

Генеральный директор
ООО «БиоЛайн»



А.В. Семенов А.В. Семенов


апрель 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:


**Микротом ротационный HistoCore (Rotary Microtome HistoCore)
в вариантах исполнения с принадлежностями**

г. Москва, 2020

**1. Микротом ротационный HistoCore AUTOCUT (Rotary Microtome HistoCore AUTOCUT),
в составе:**

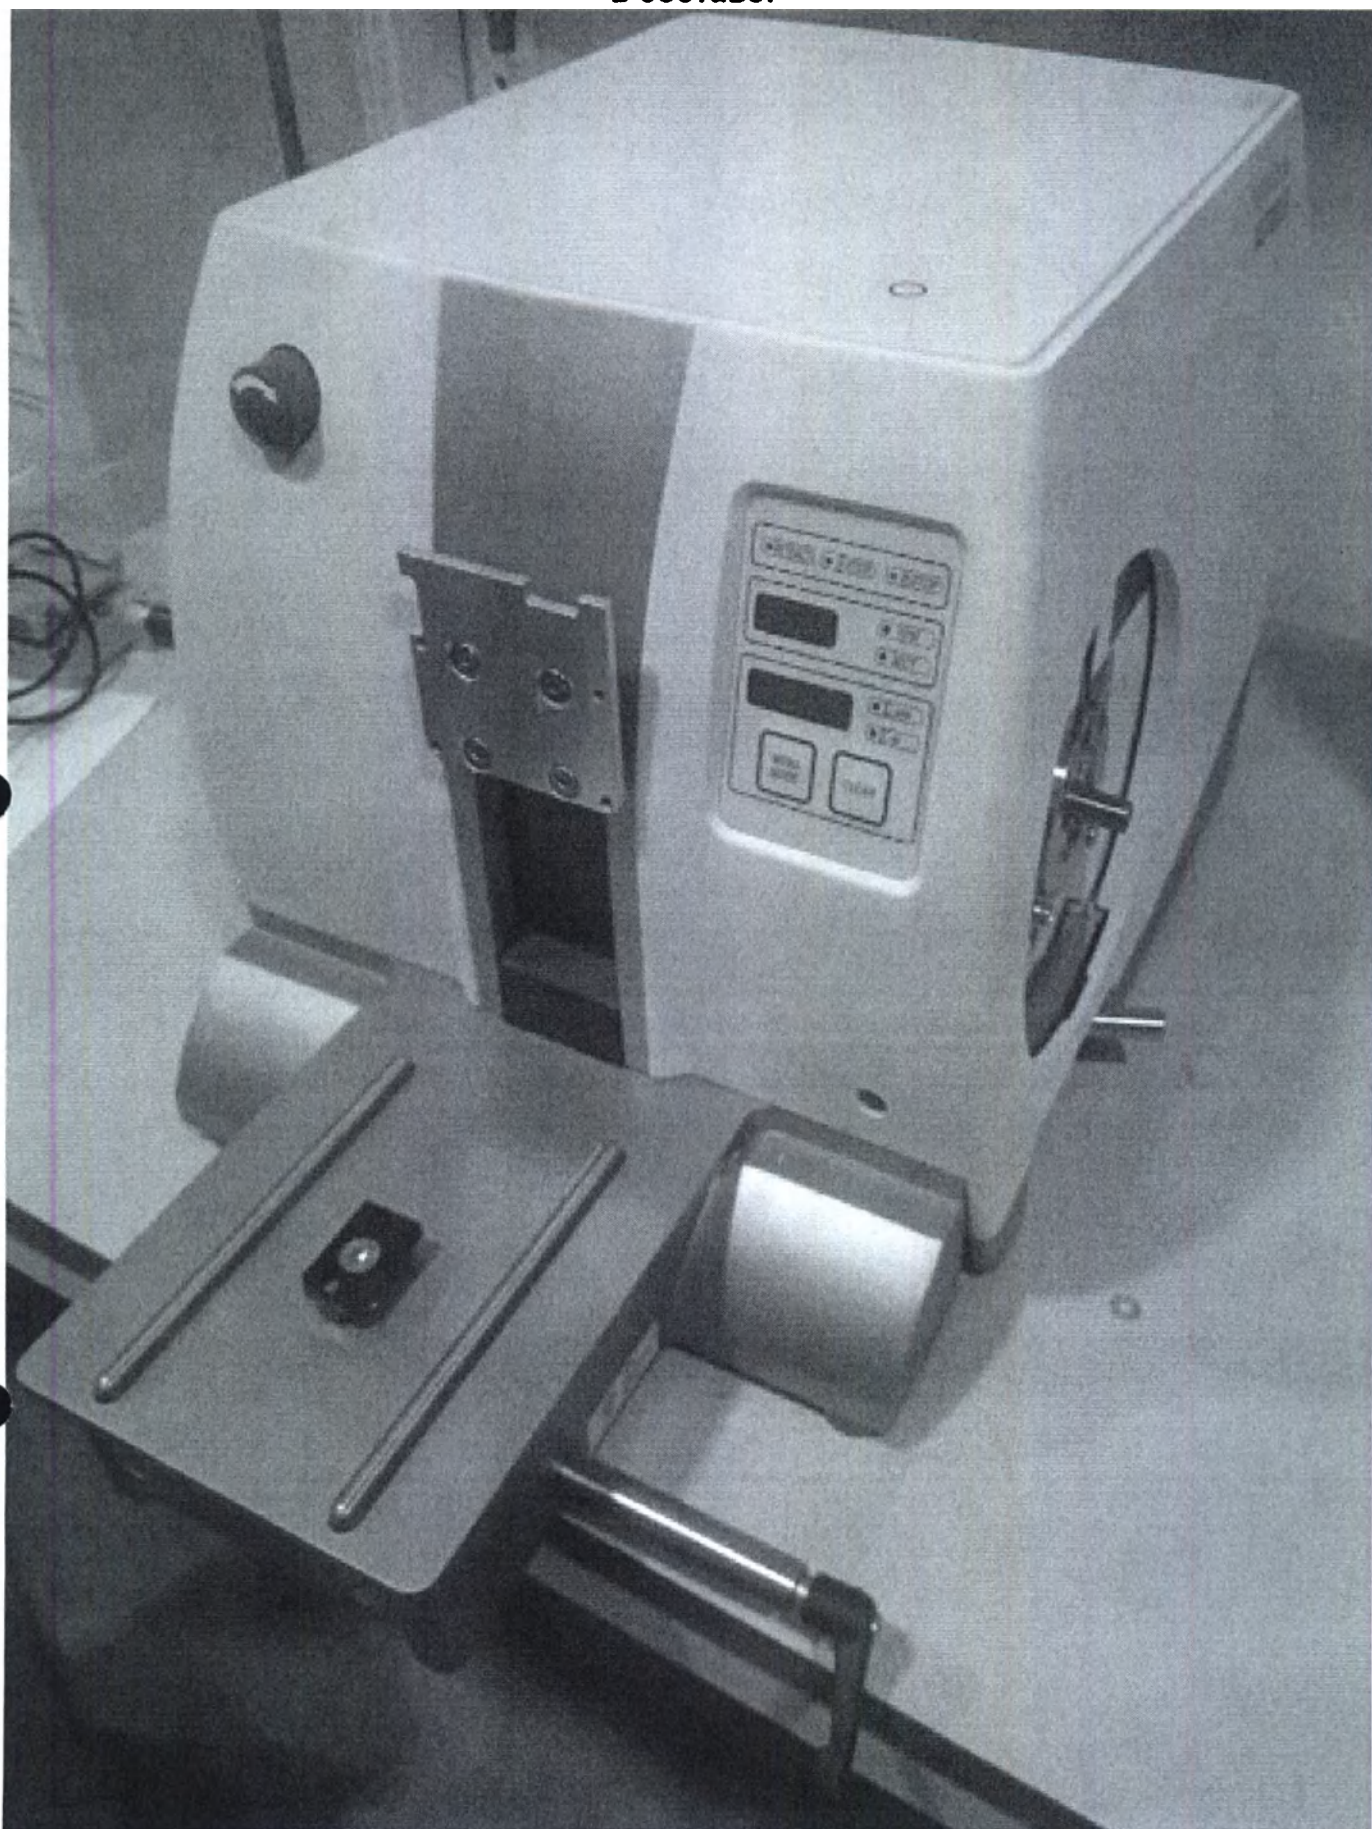

1. Прибор базовый HistoCore AUTOCUT (Basic instrument HistoCore AUTOCUT)

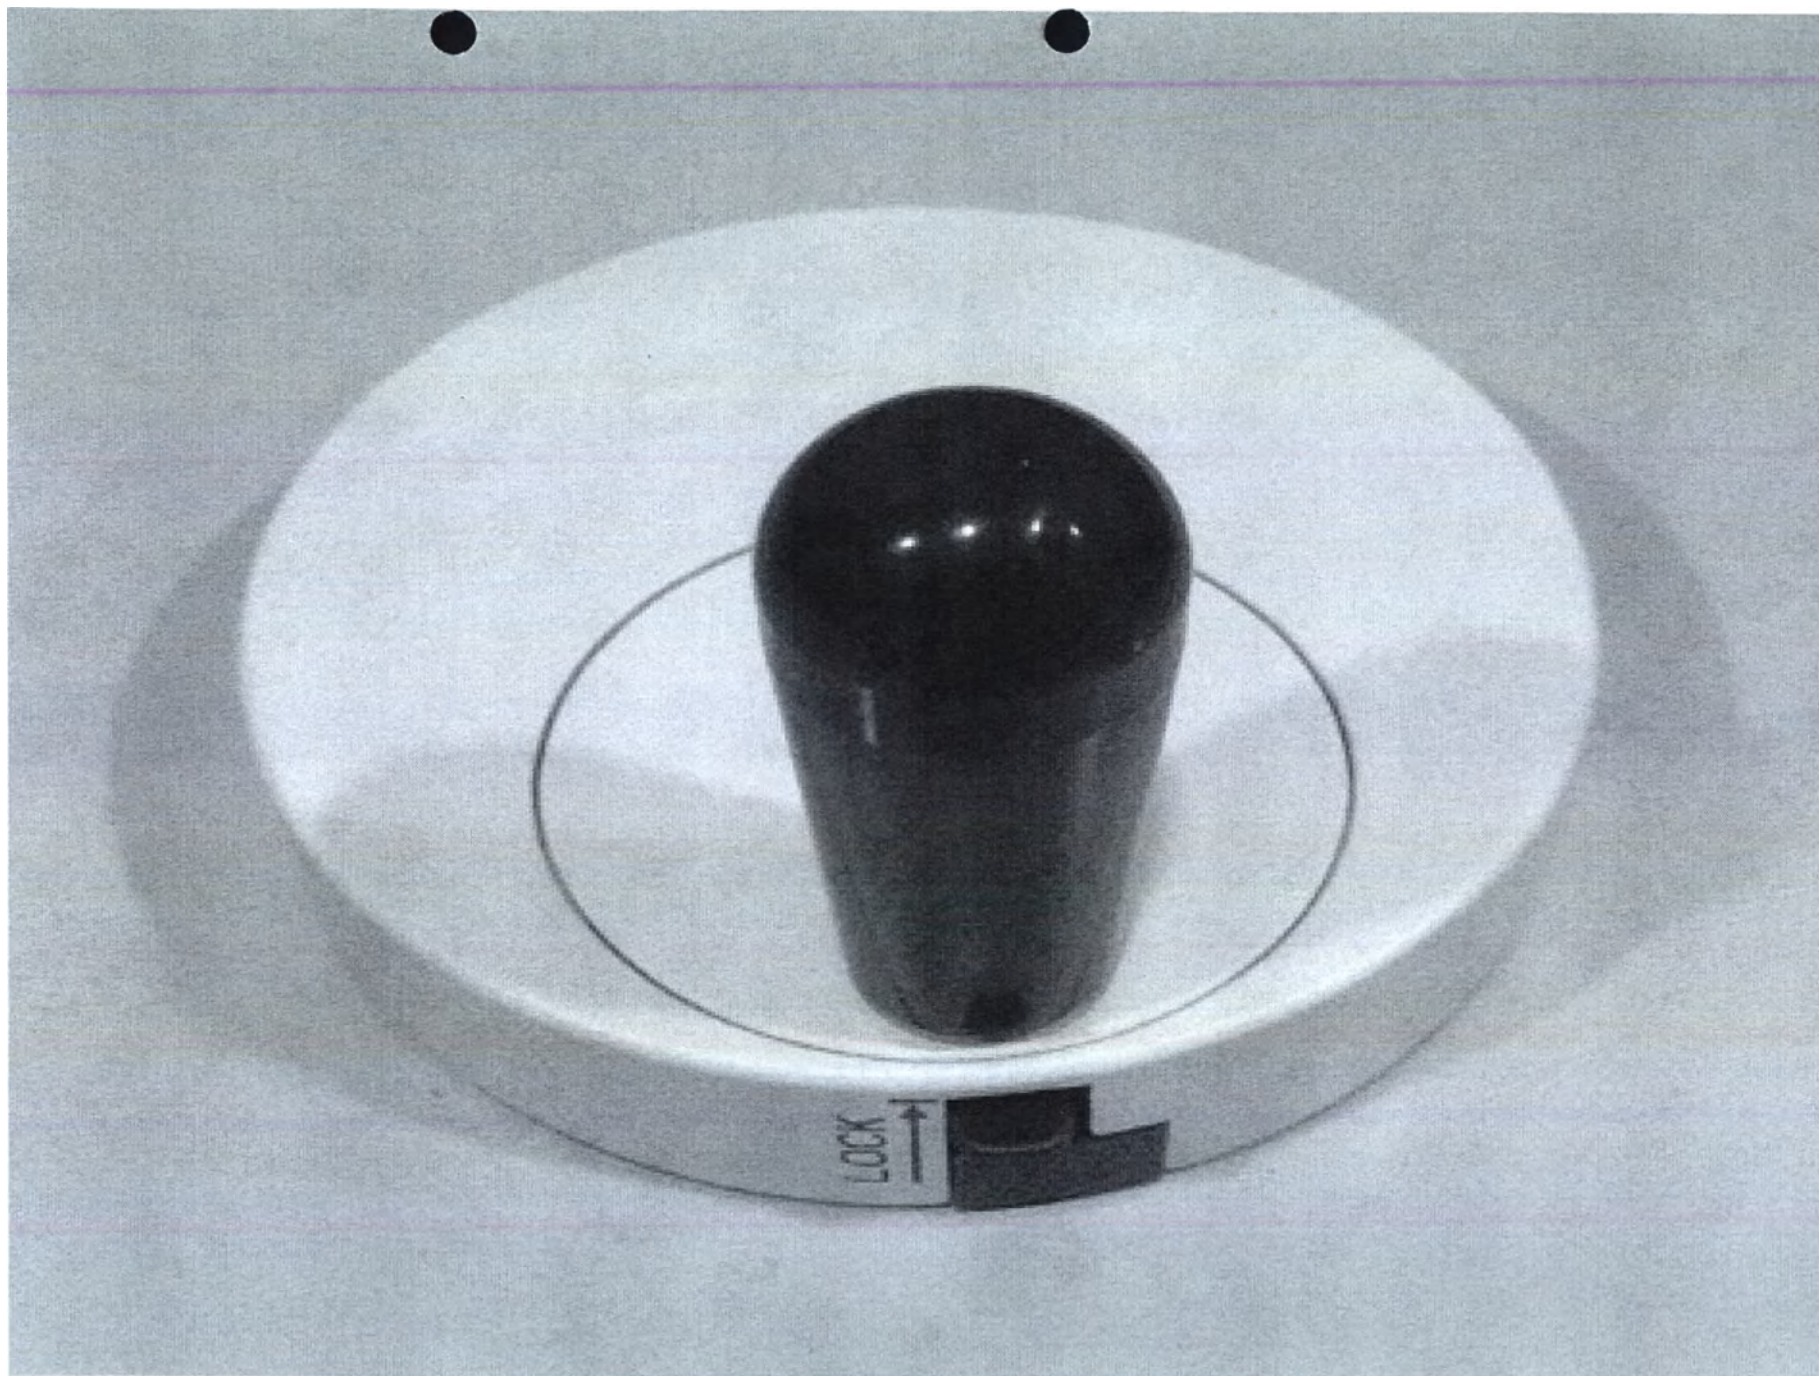


2. Маховик, в сборе (Handwheel, assembly)



3. Панель управления отдельная, HistoCore AUTOCUT (Separate control panel, HistoCore AUTOCUT)



4. Лоток для отходов антистатический (Anti-static waste tray)

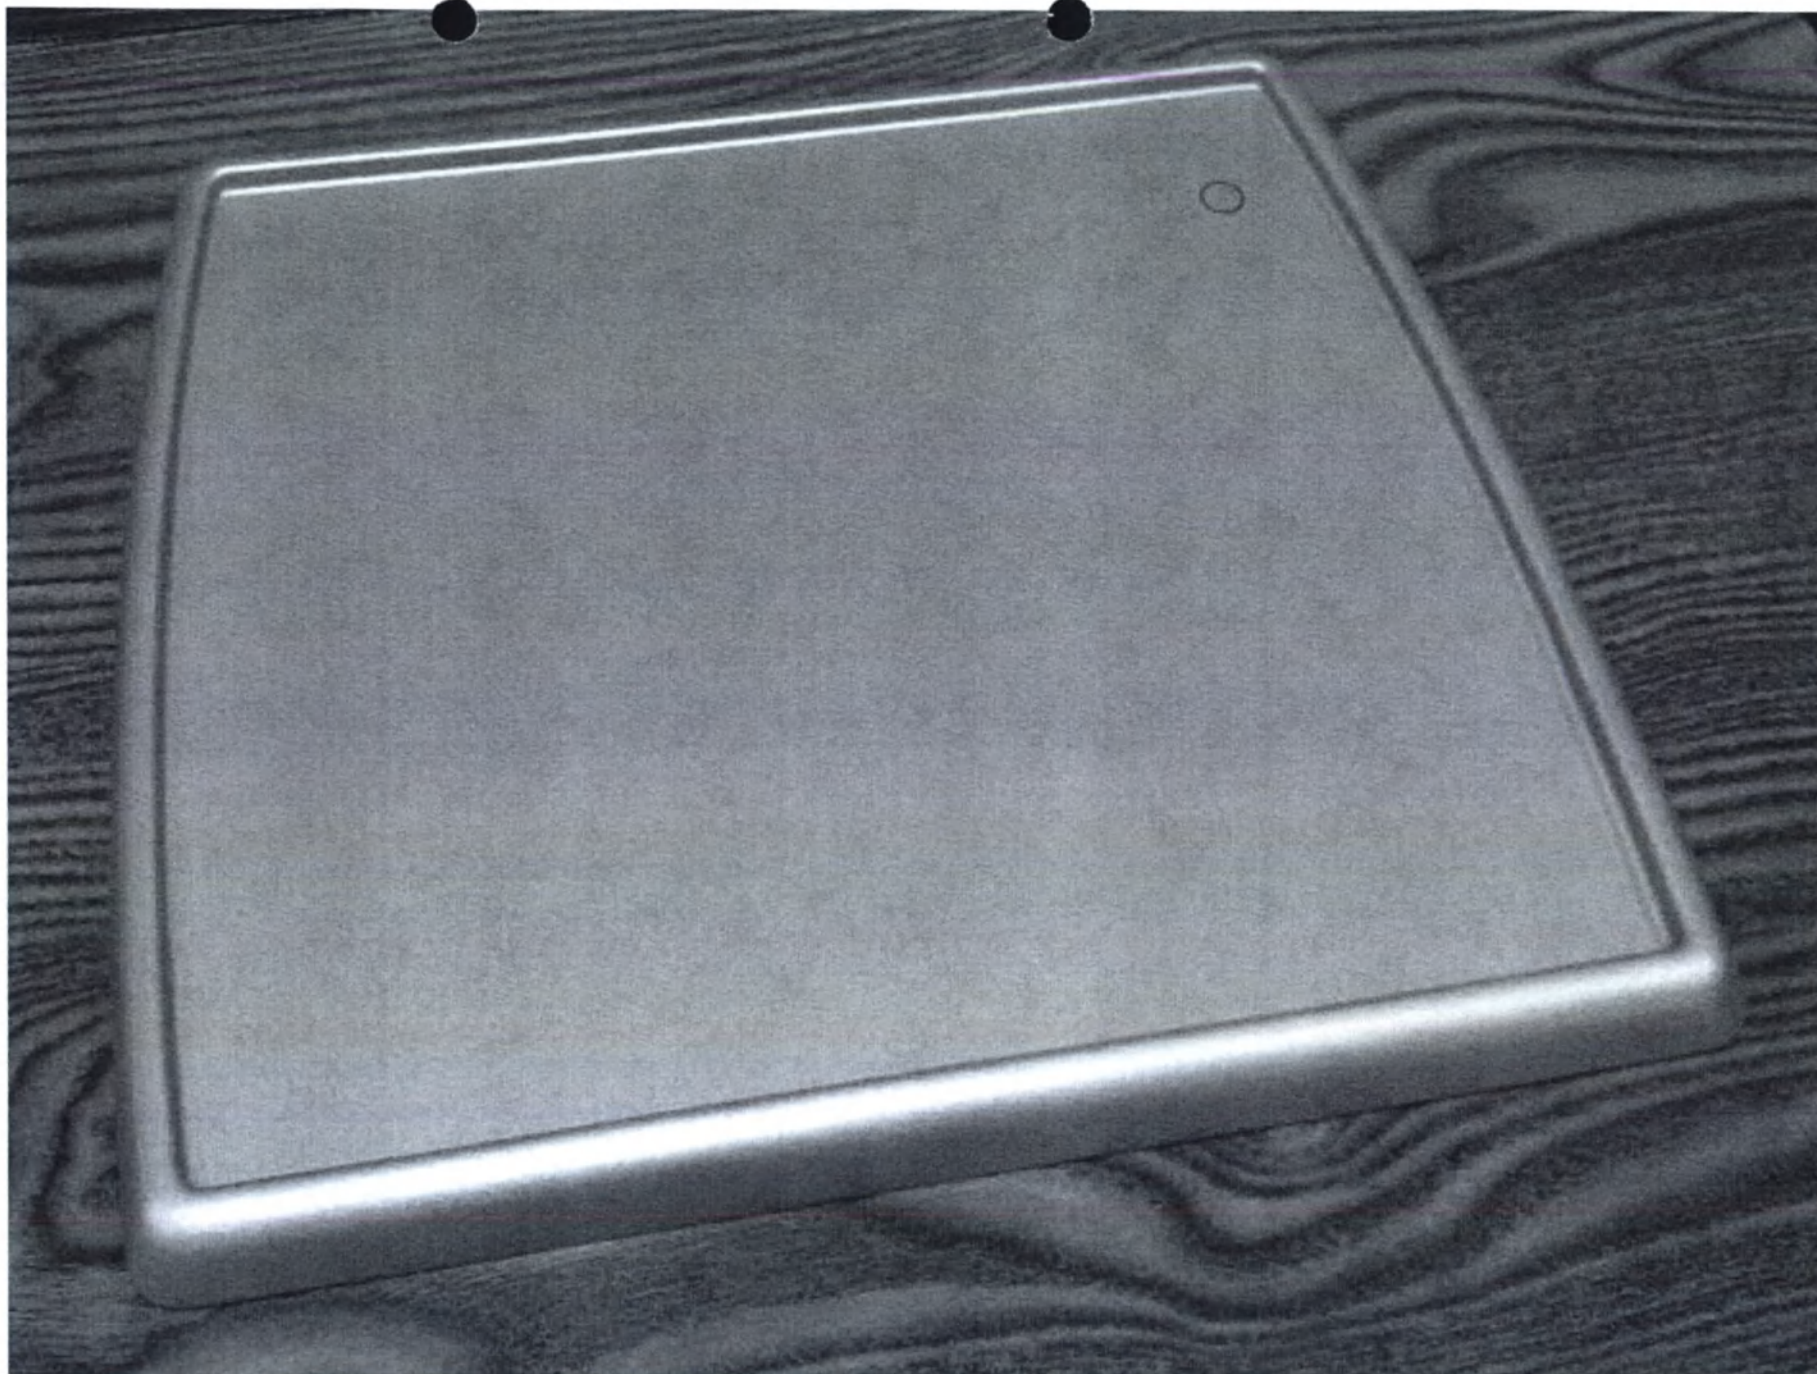

5. Лоток верхний (Top tray)




6. Набор сервисный (Service pack) – 1шт., в составе:




6. Набор сервисный (Service pack) – 1шт., в составе:



6.1. Ключ Аллена №5 с рукояткой (Allen key №5 with handle)

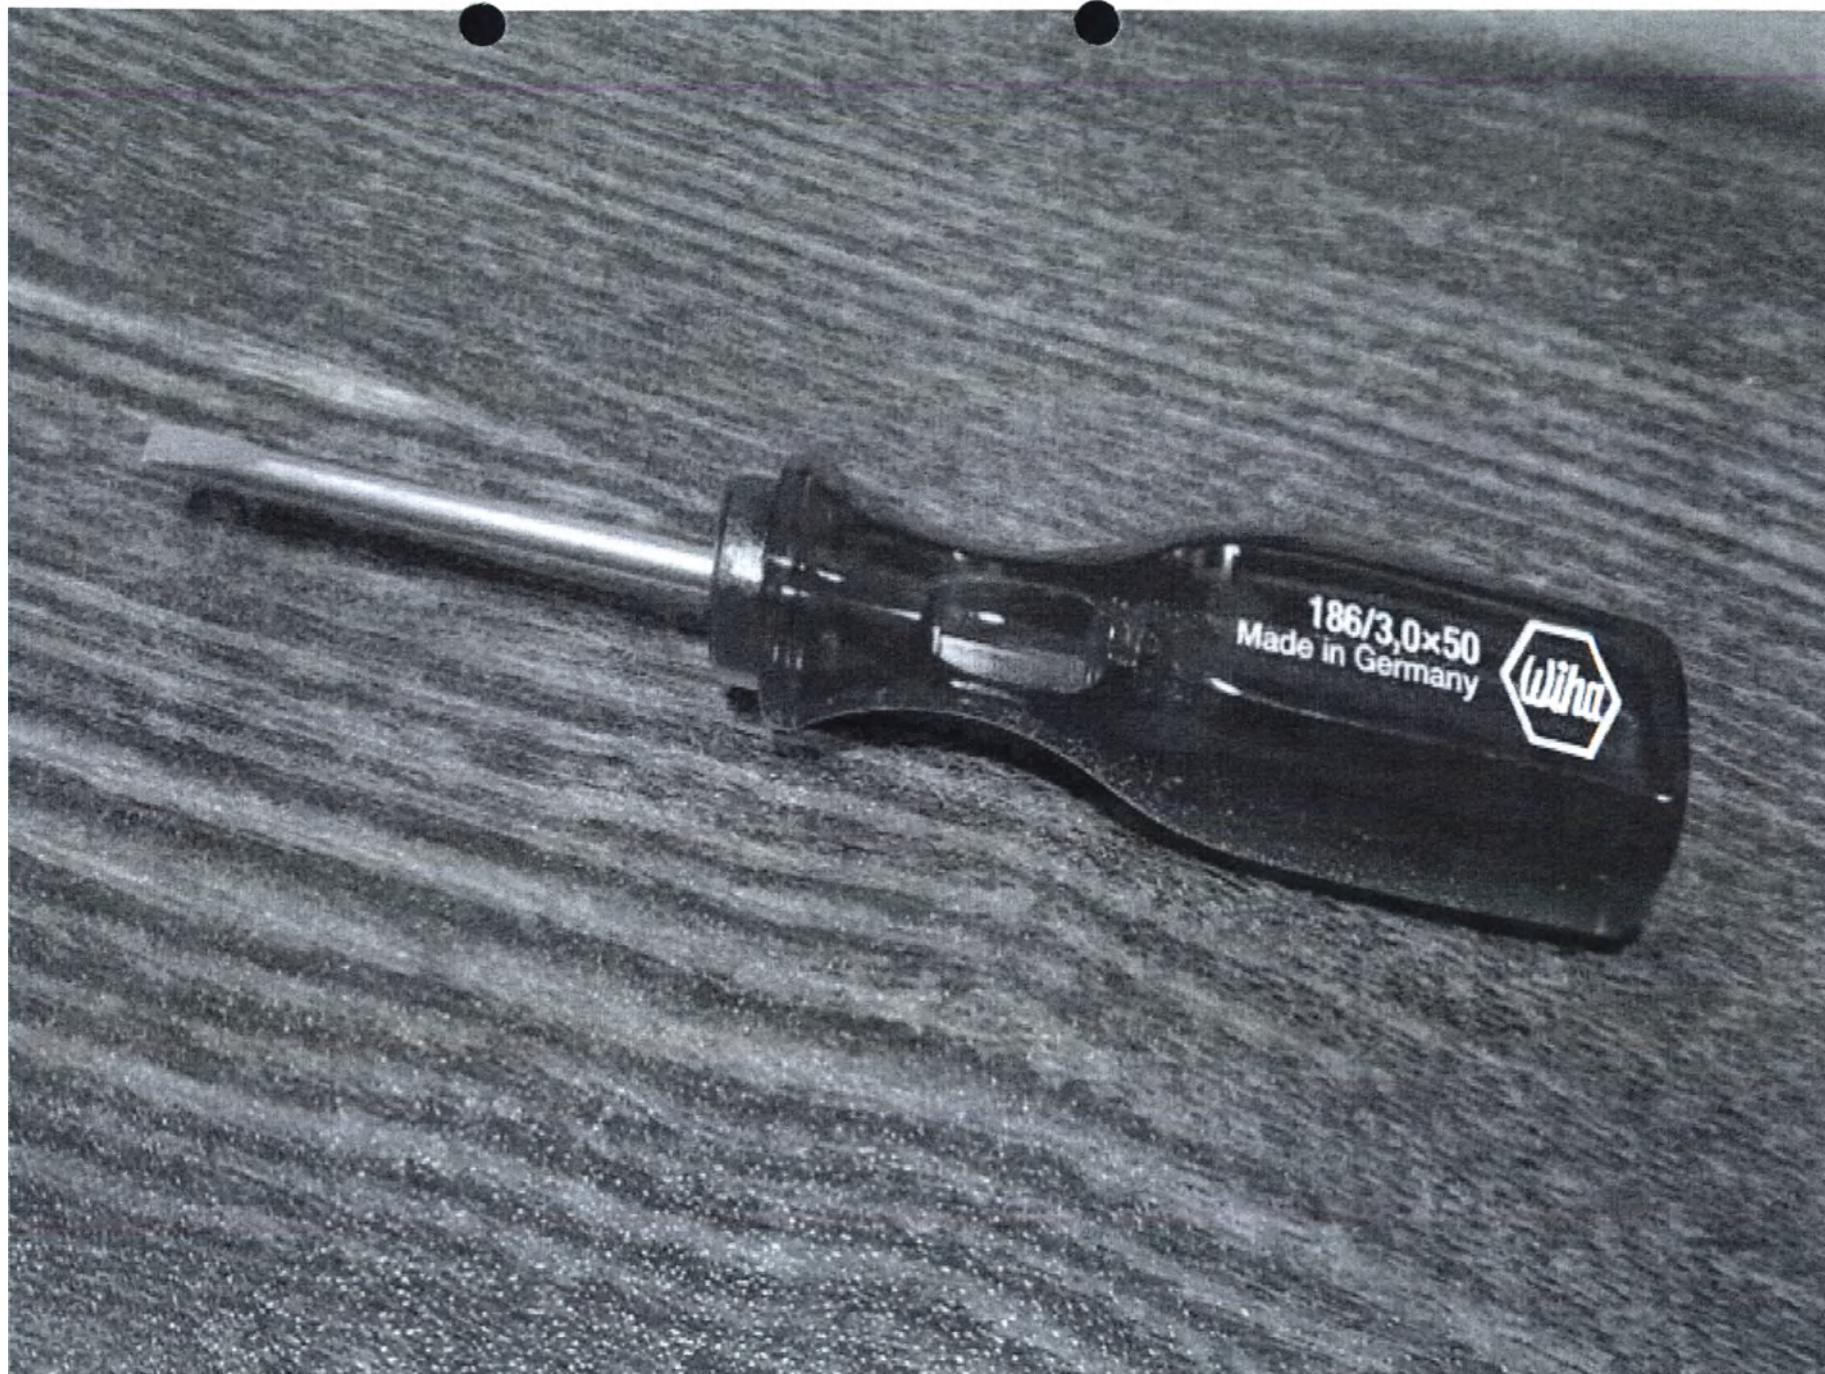


6.2. Отвертка 3мм × 50мм (Screwdriver 3mm × 50mm)

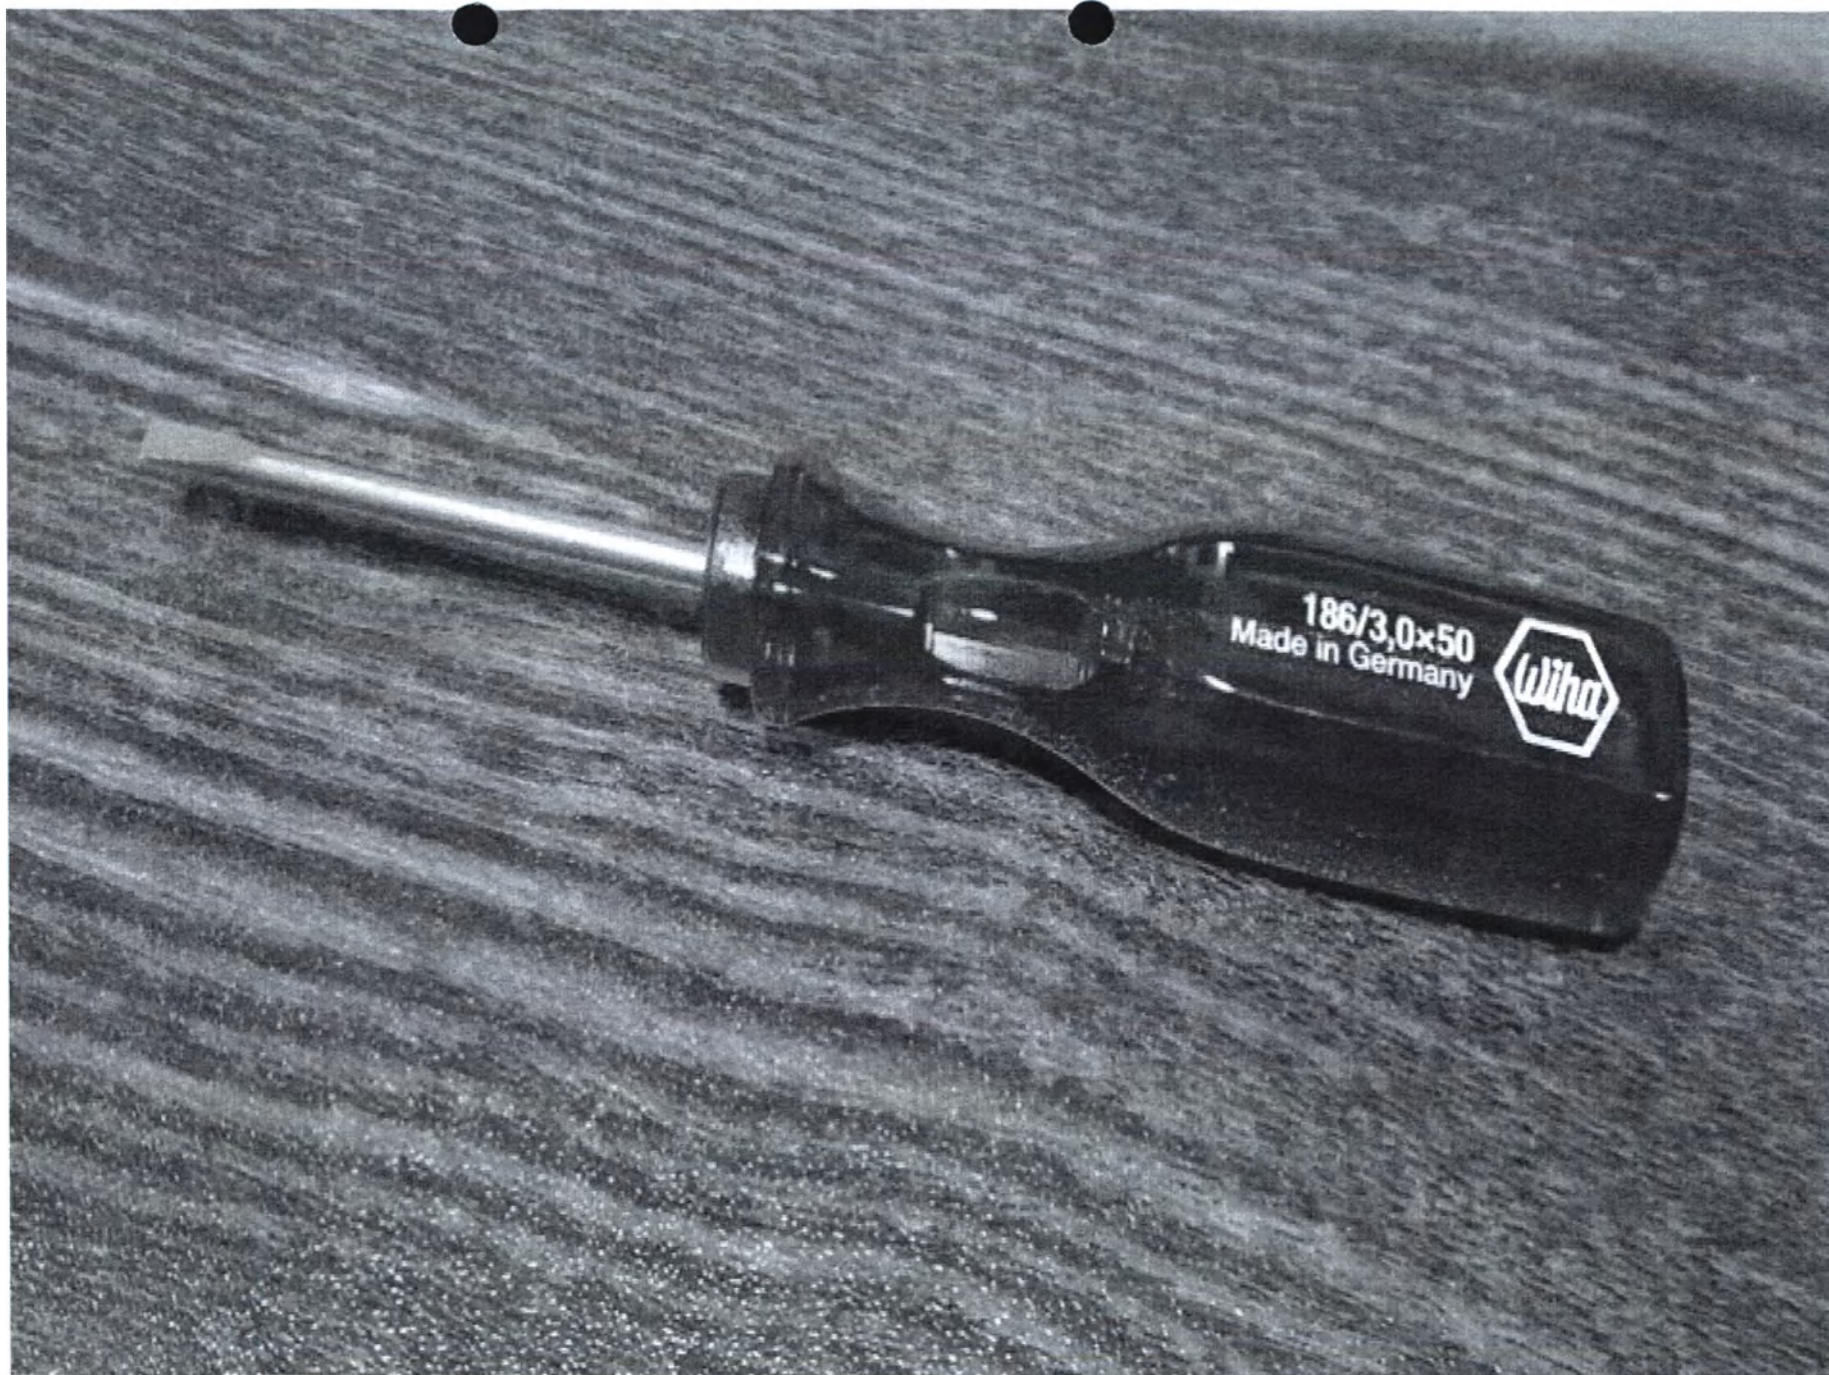

6.2. Отвертка 3мм × 50мм (Screwdriver 3mm × 50mm)




6.2. Отвертка 3мм × 50мм (Screwdriver 3mm × 50mm)

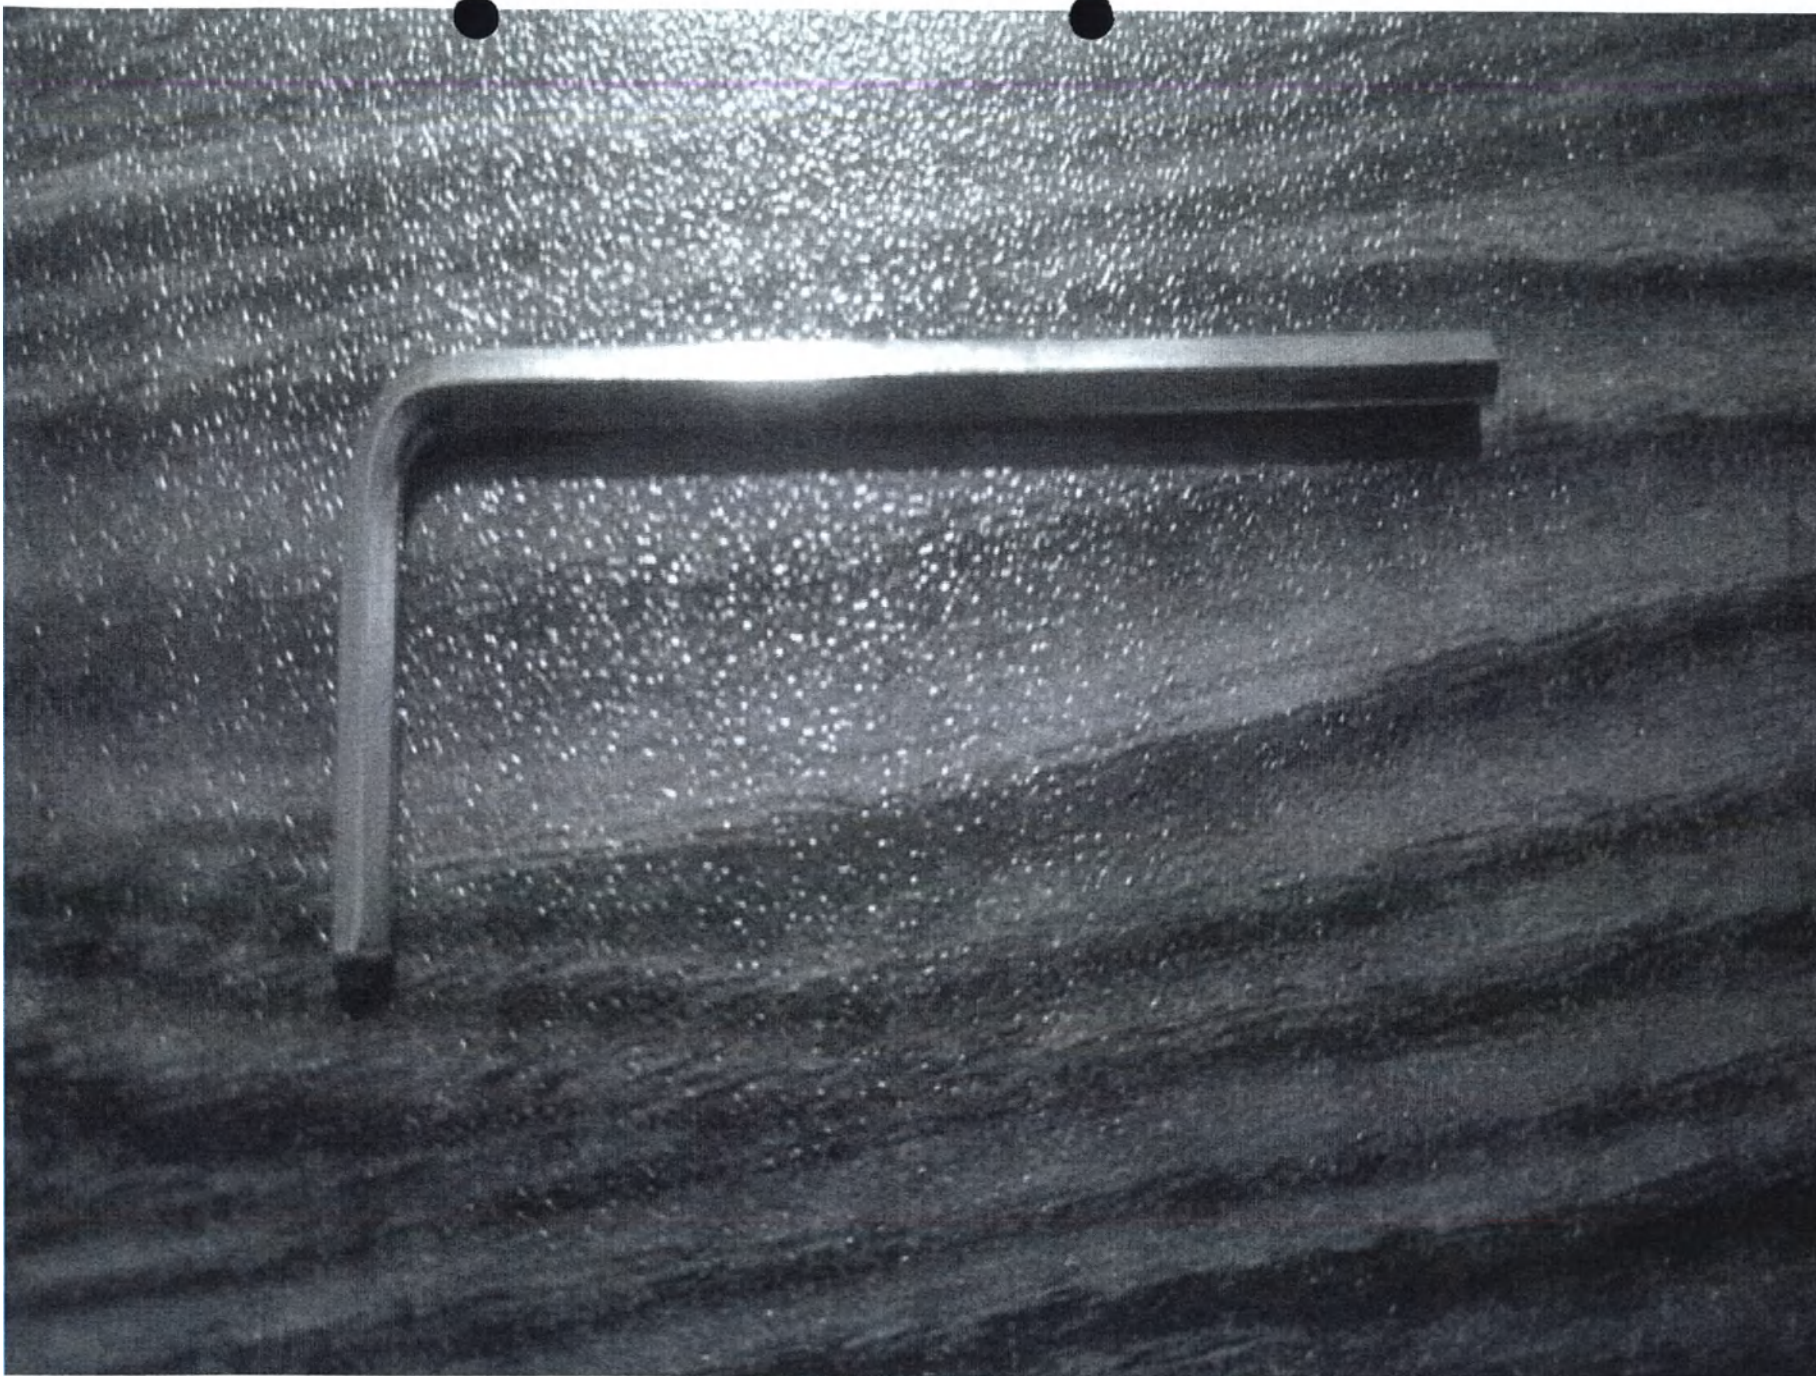


6.3. Ключ Аллена №3 (Allen key №3)



6.4. Ключ Аллена №4 (Allen key №4)

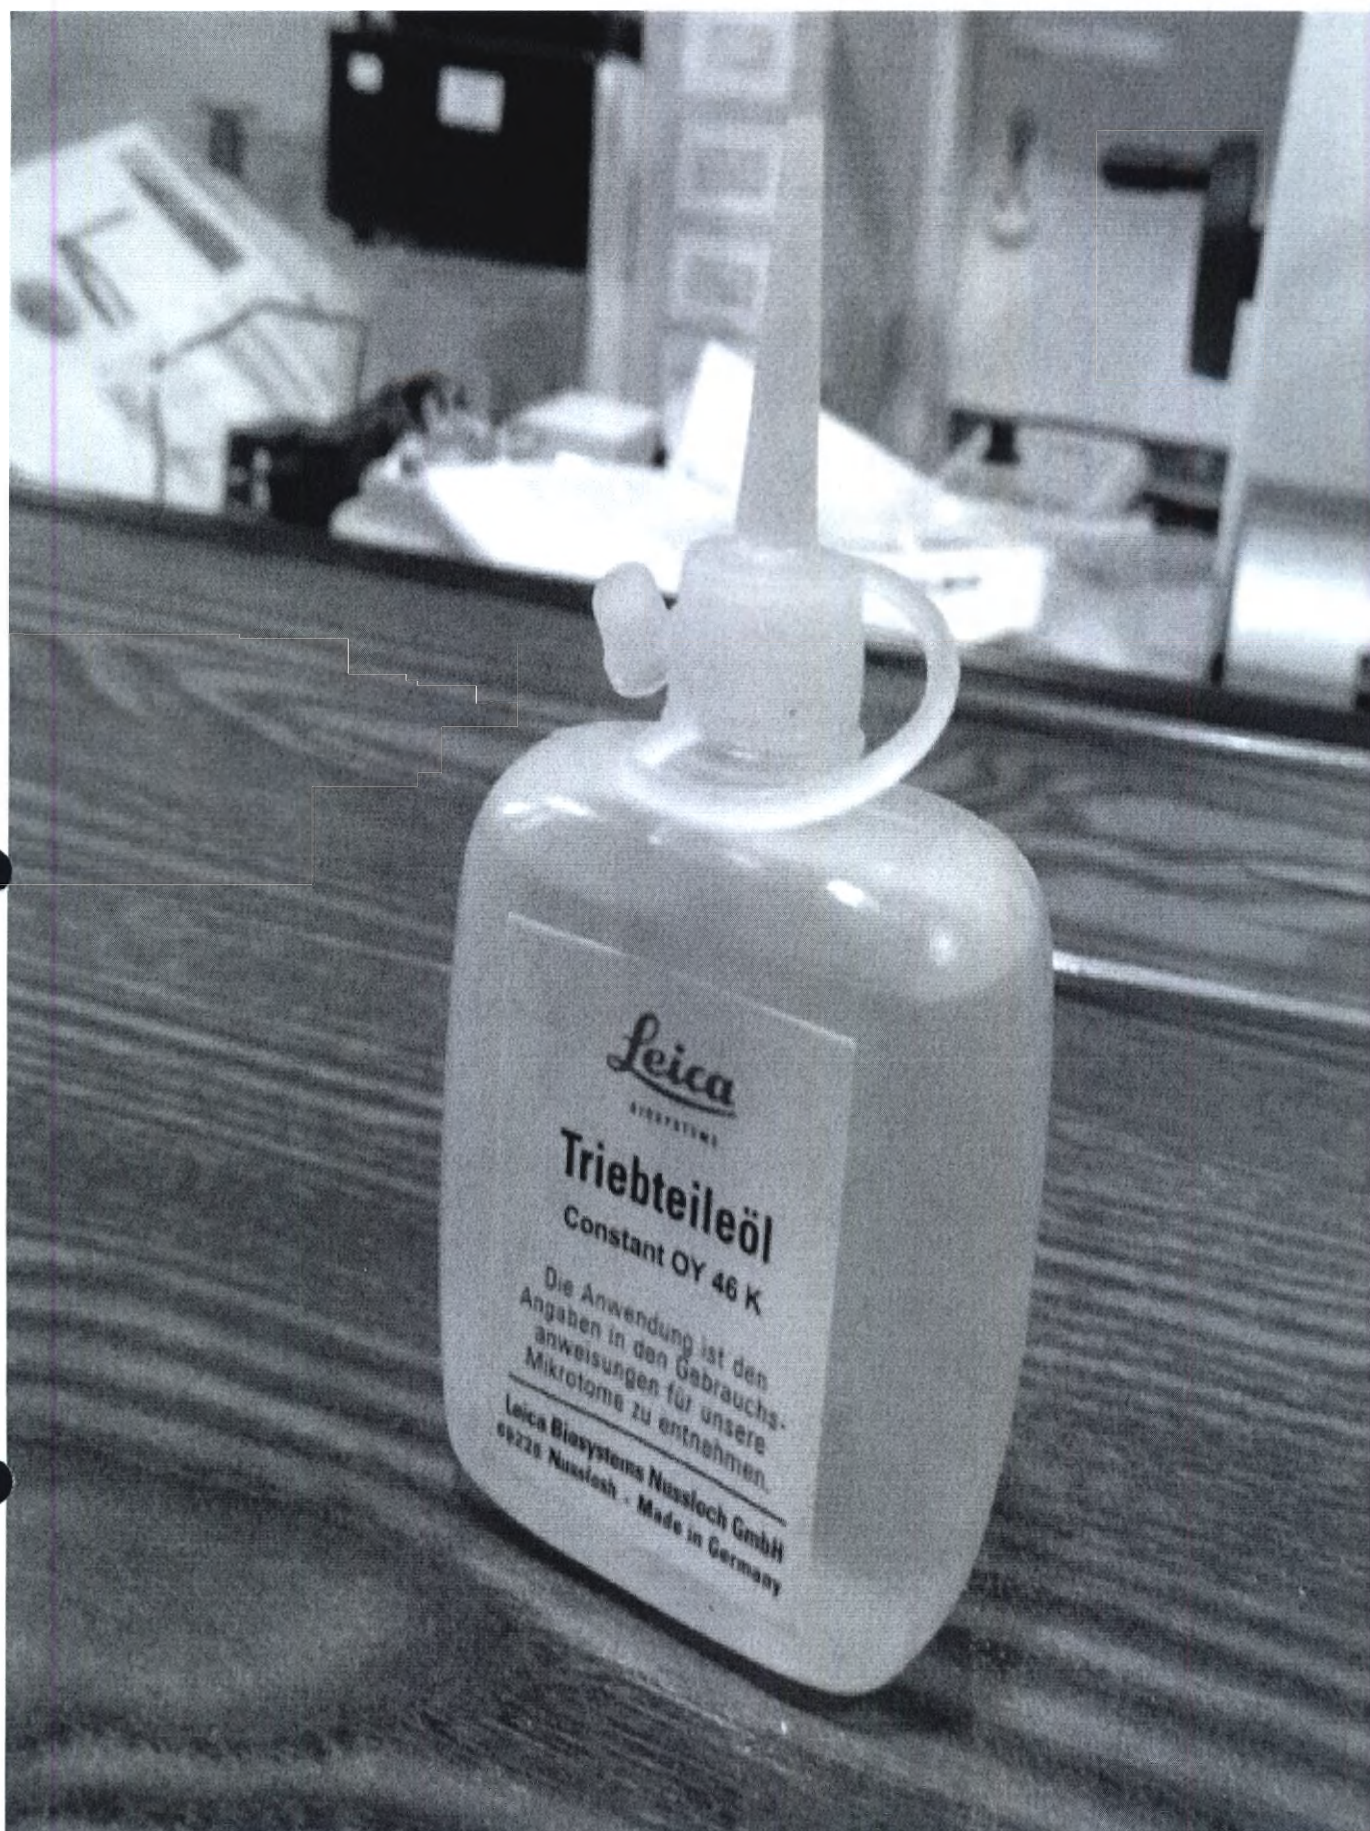

6.5. Масло машинное, 50мл (Oil for drives, 50 ml)

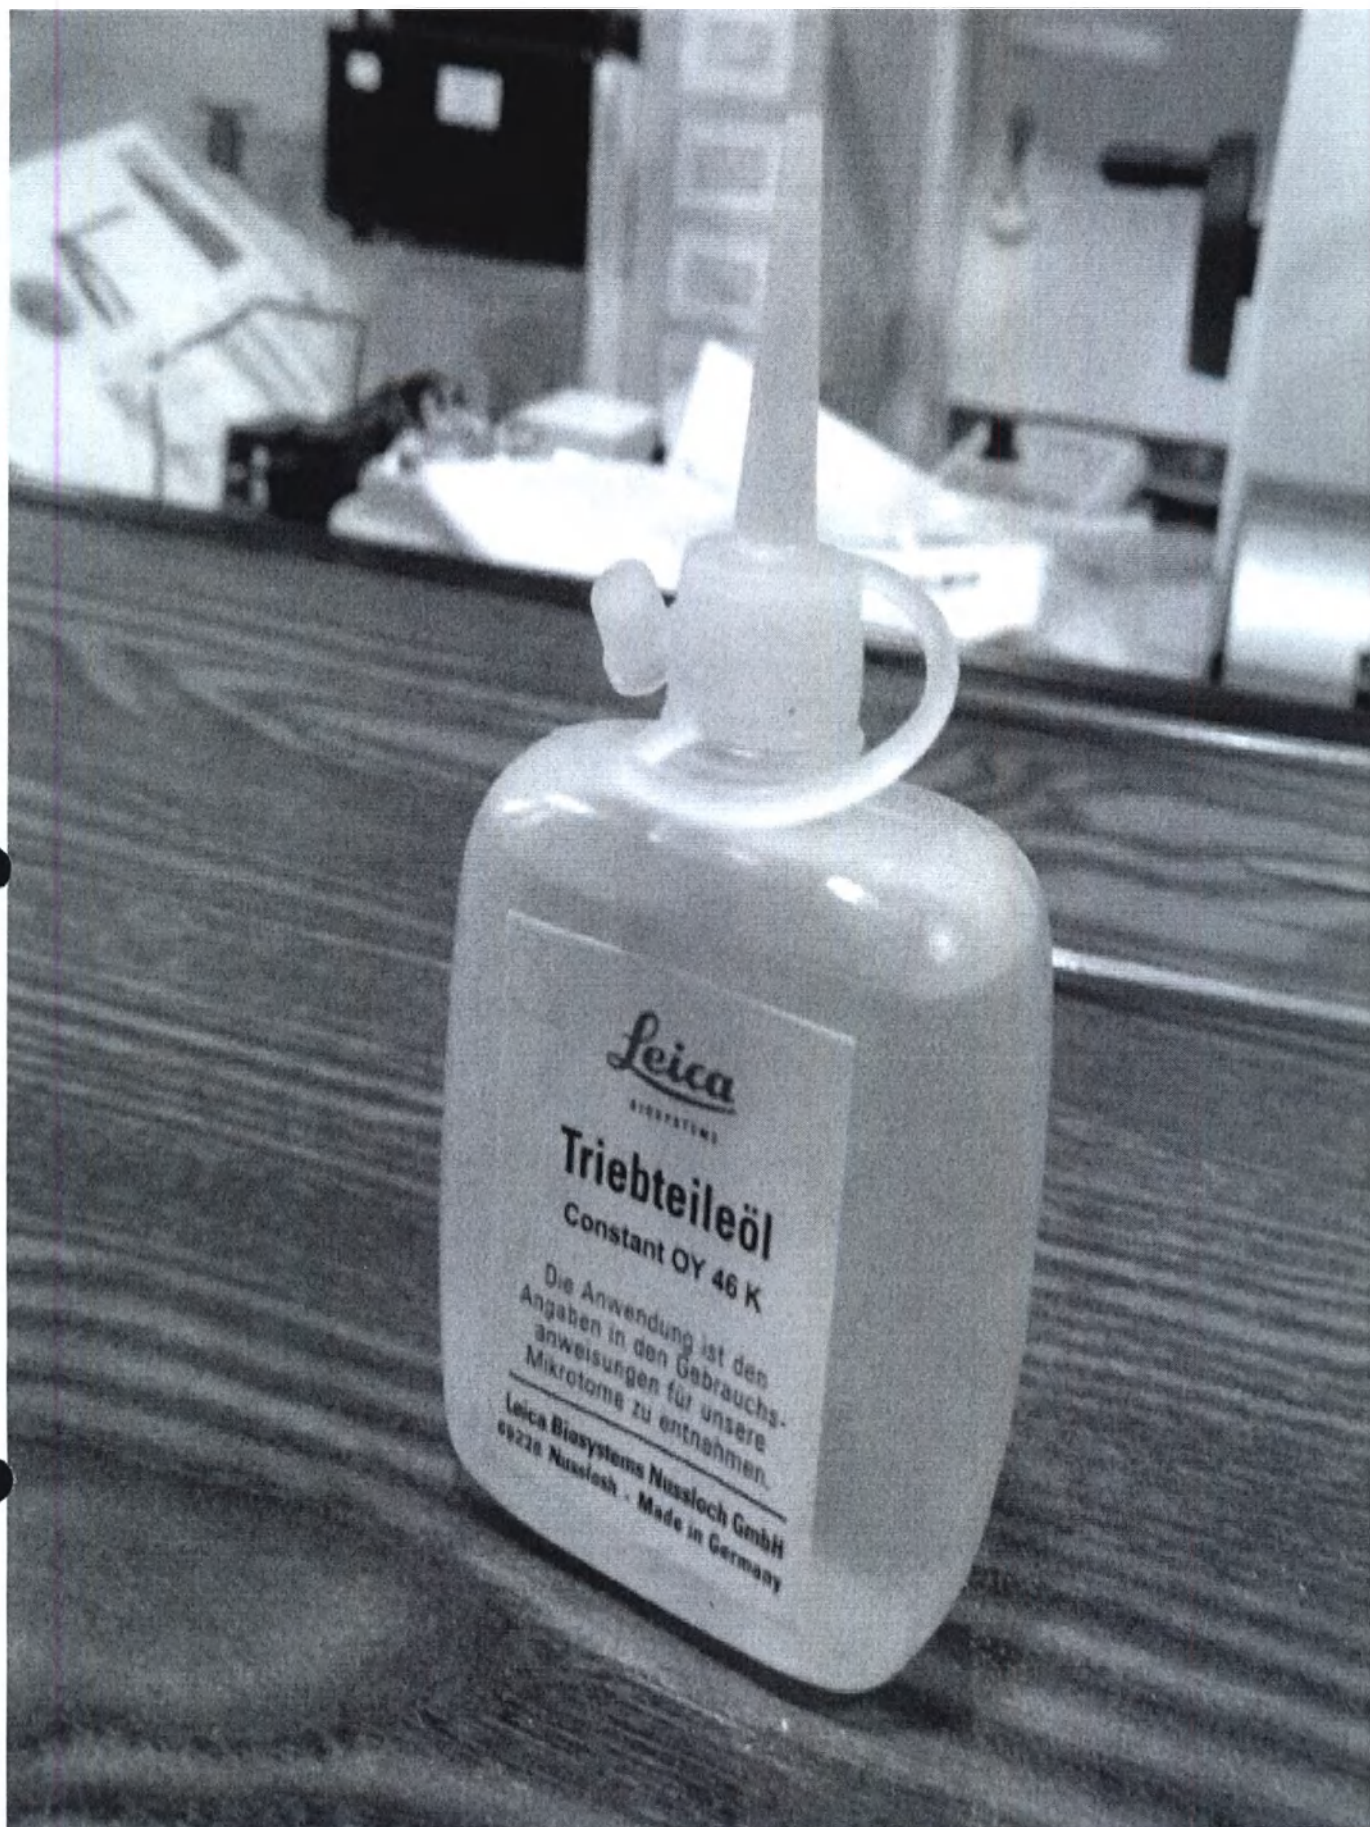

6.5. Масло машинное, 50мл (Oil for drives, 50 ml)




6.6. Кисть с магнитом (Brush with magnet)




6.7. Колпак пылезащитный (Dust cover)




7. Предохранитель плавкий Т 3,15АL, 250В (Fuse Lead T 3,15AL, 250V)

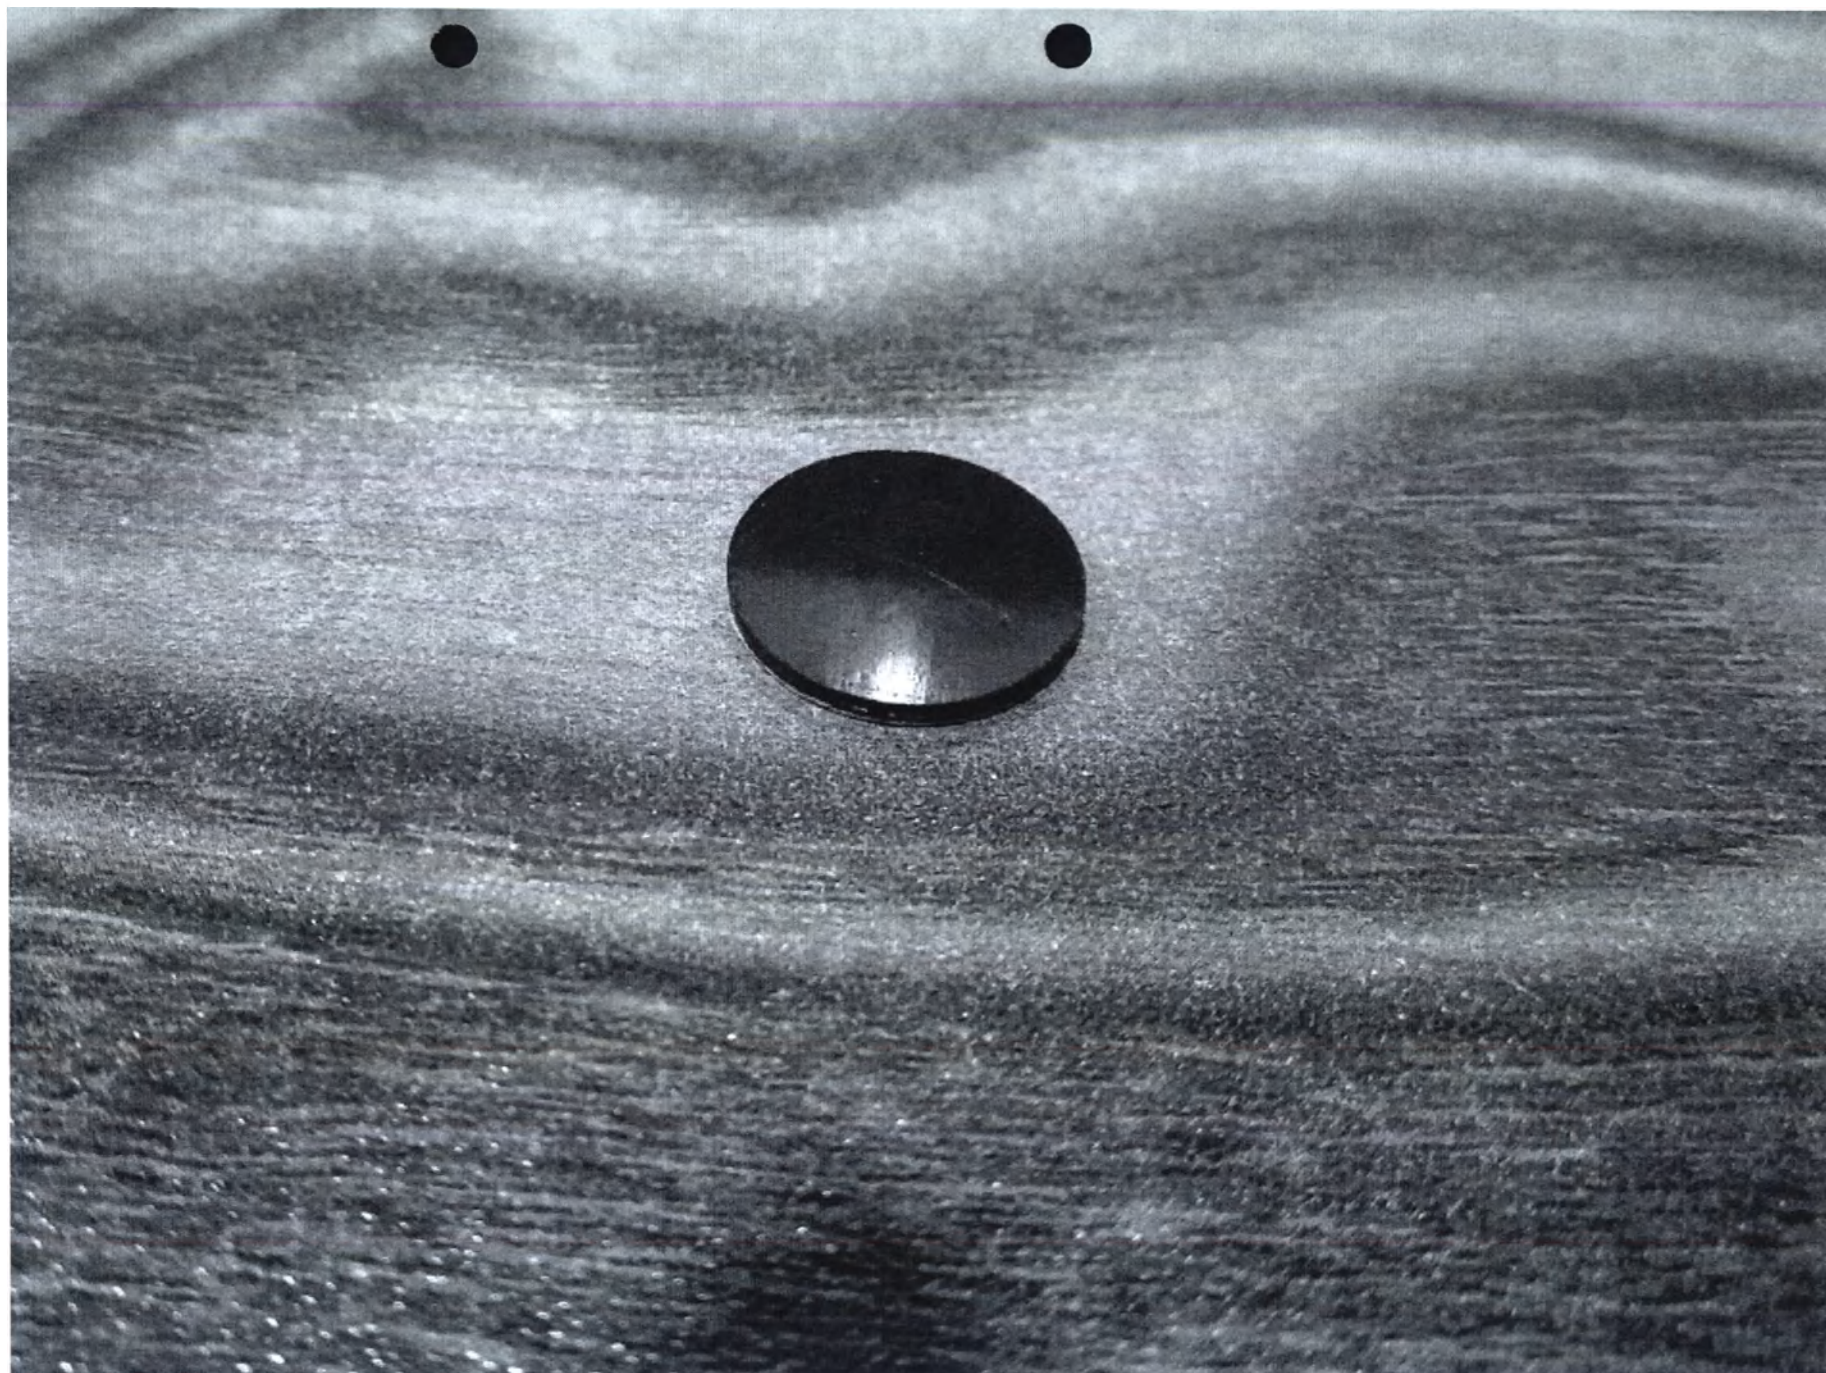


8. Крышка (Cover Disc)

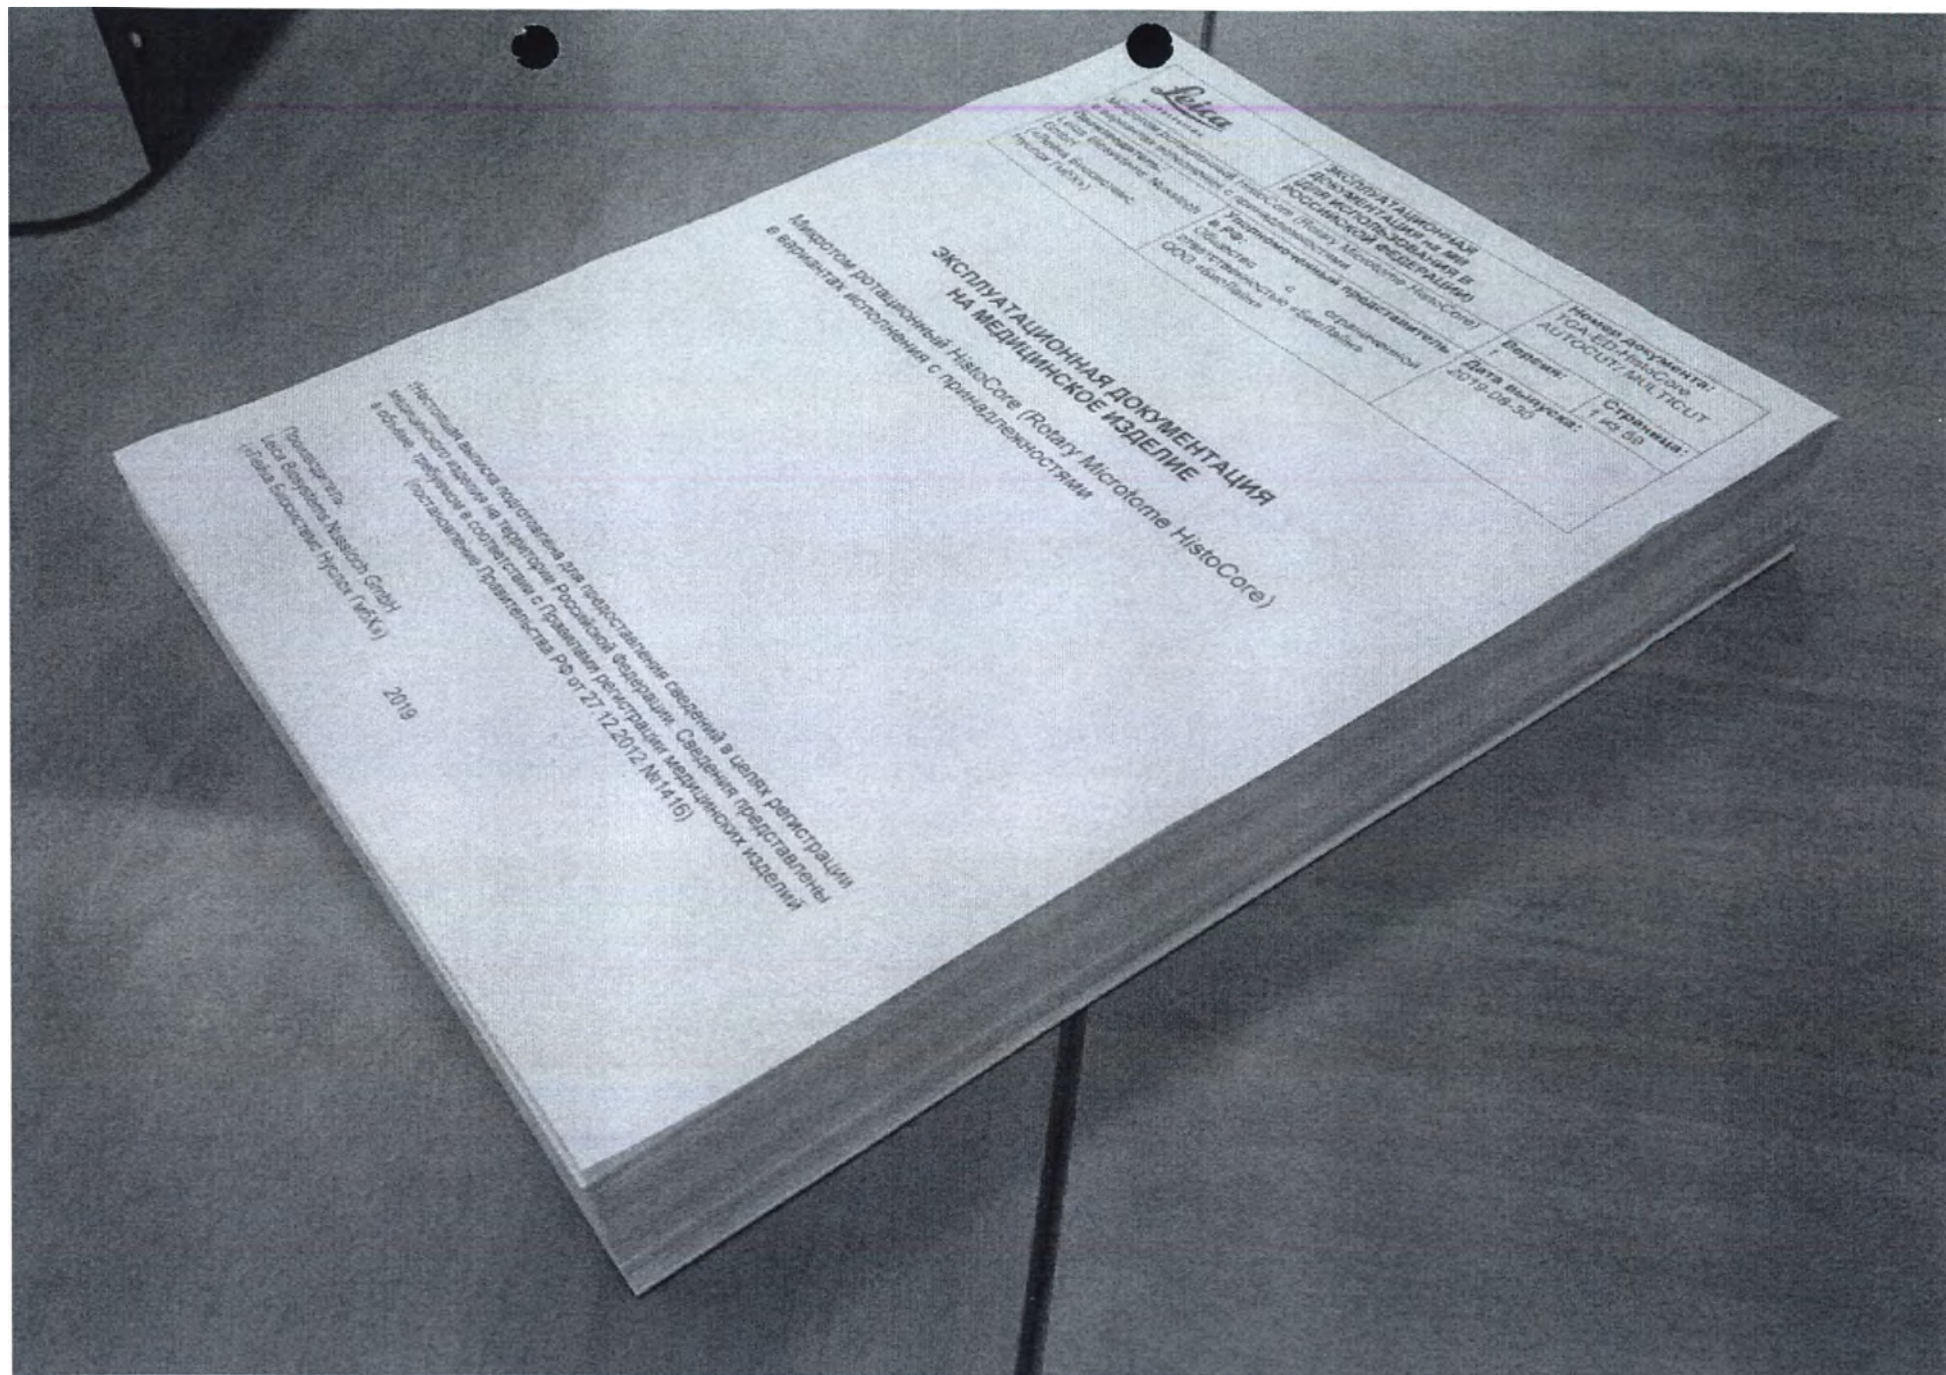


9. Комплект руководства по эксплуатации (Instructions for Use with language CD):
- руководство по эксплуатации (печатная версия);

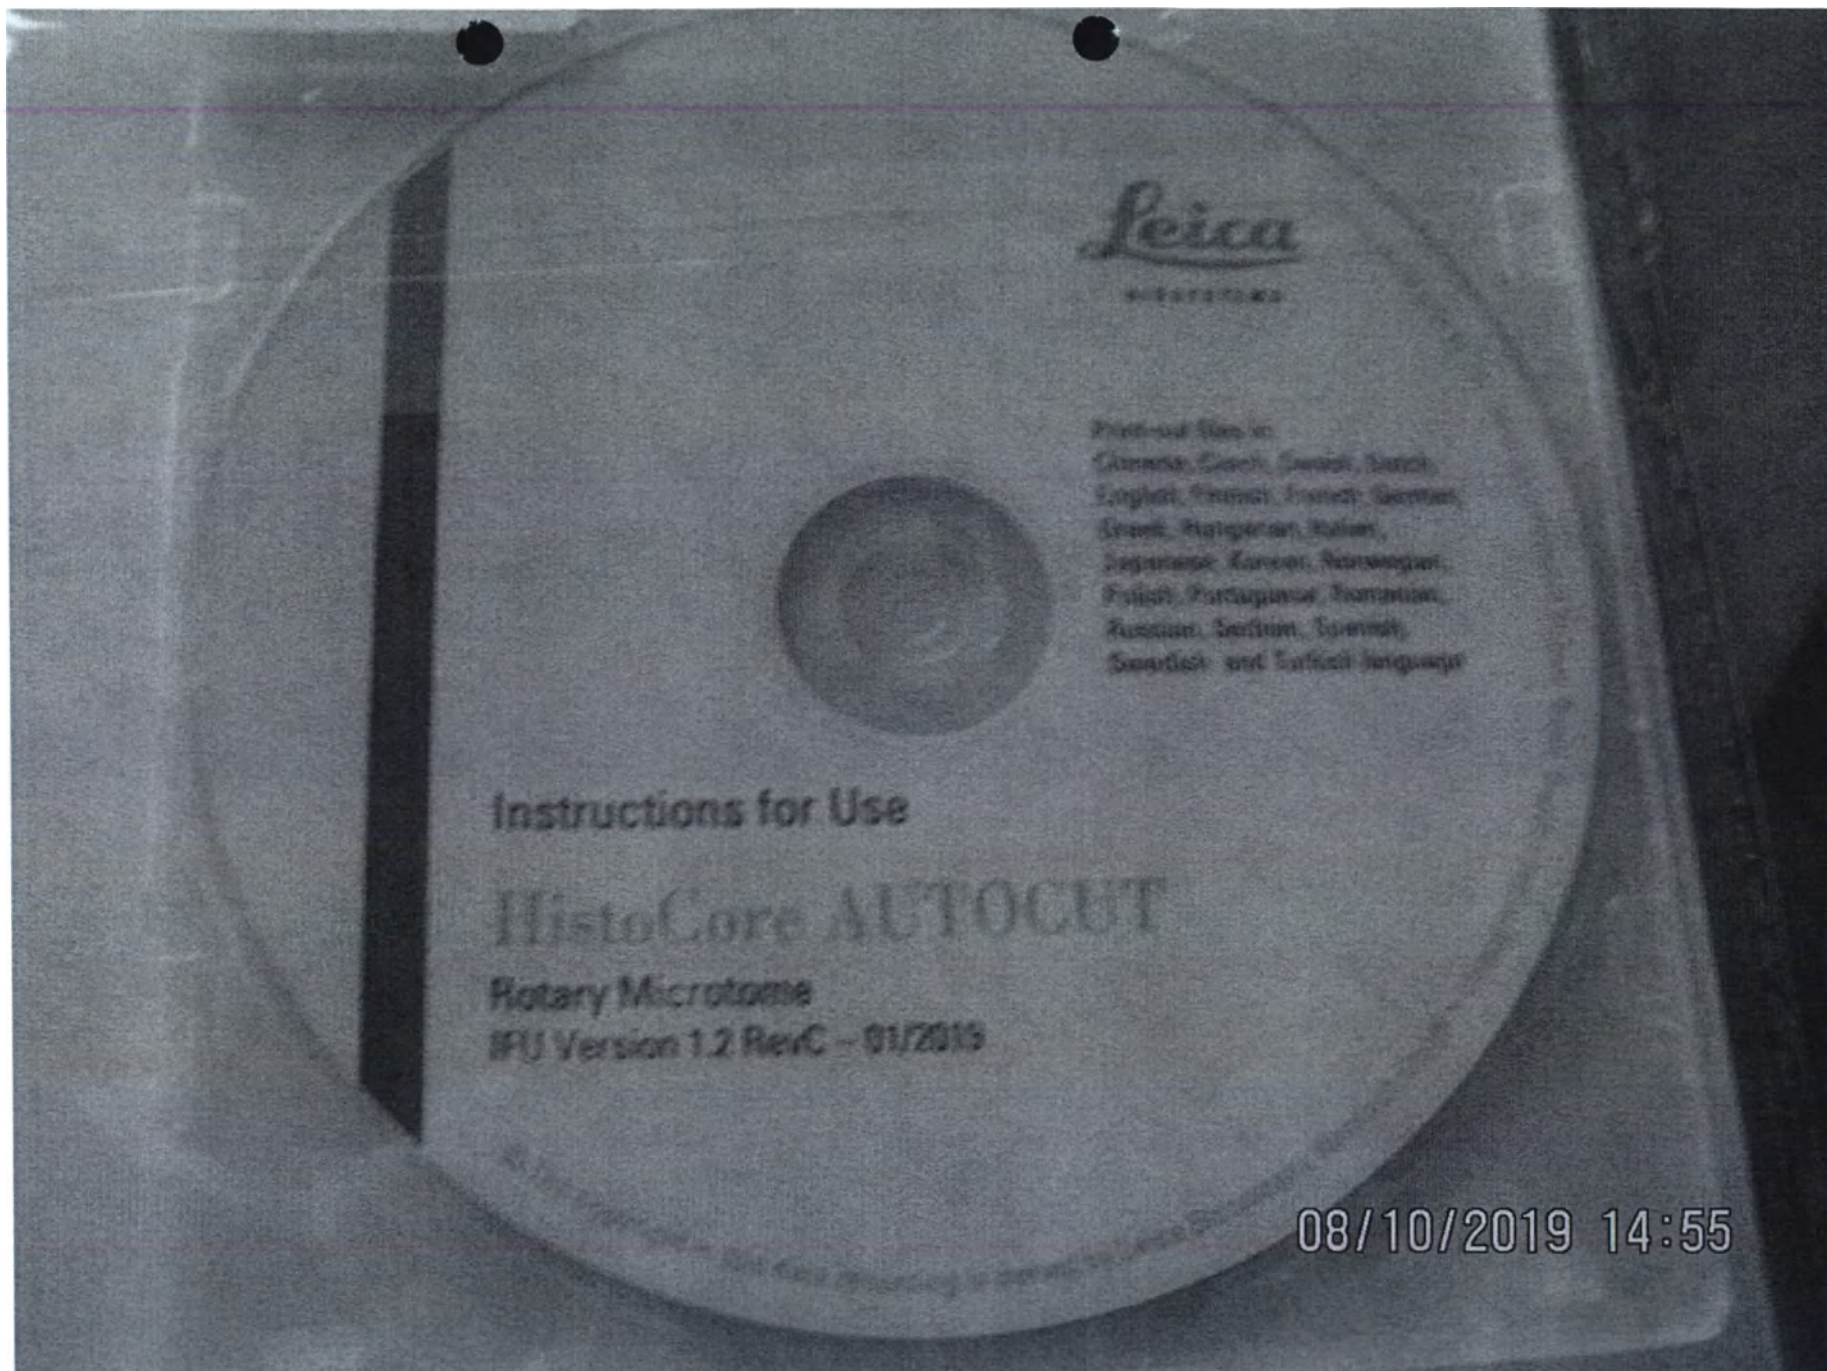


- руководство по эксплуатации на CD диске.

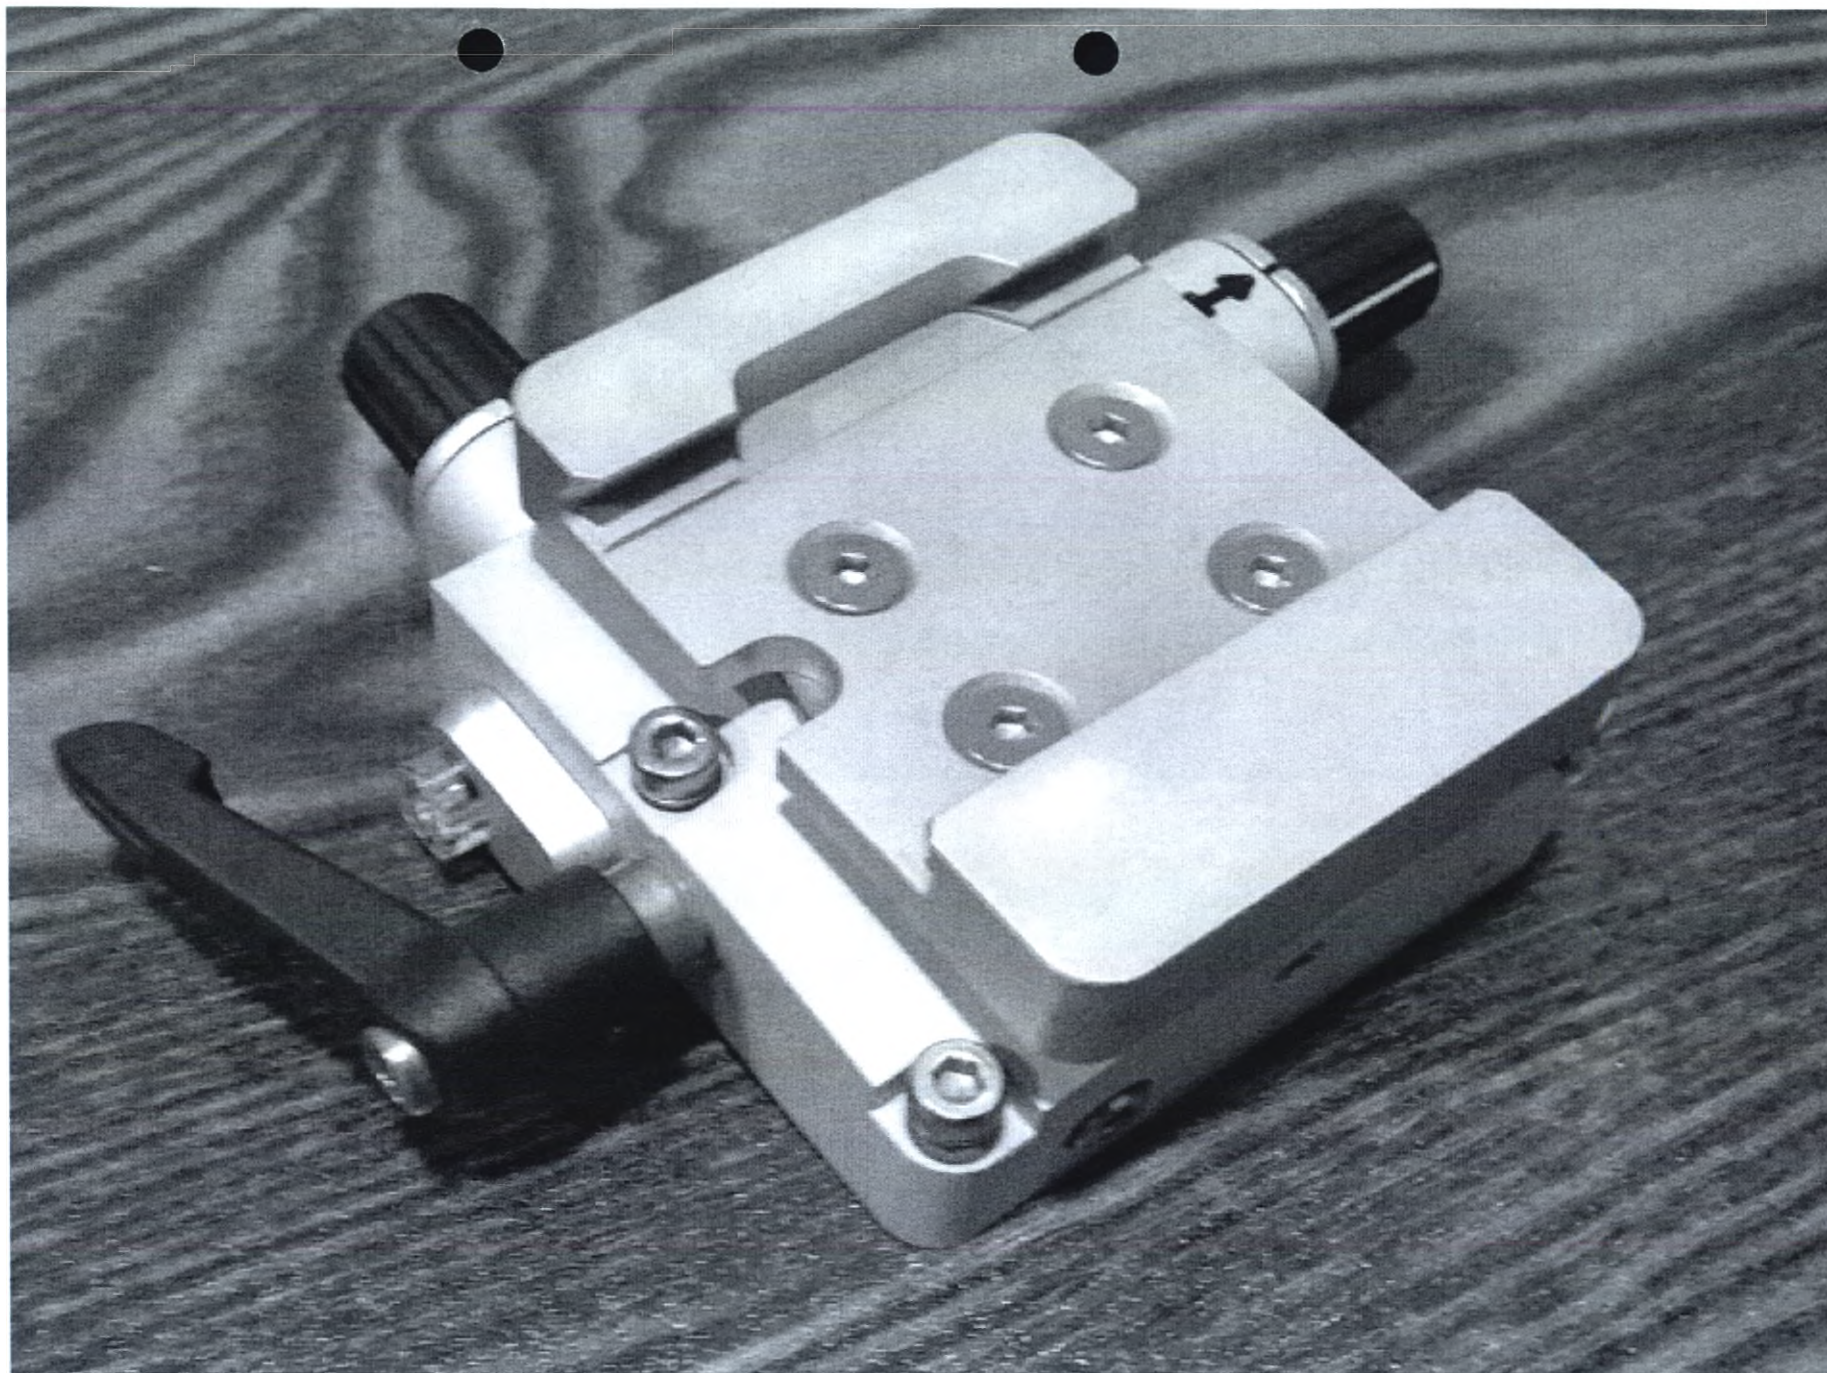


10. Крепление для быстрого зажима образца с точной ориентацией (Fine-directional fixture for specimen clamp)

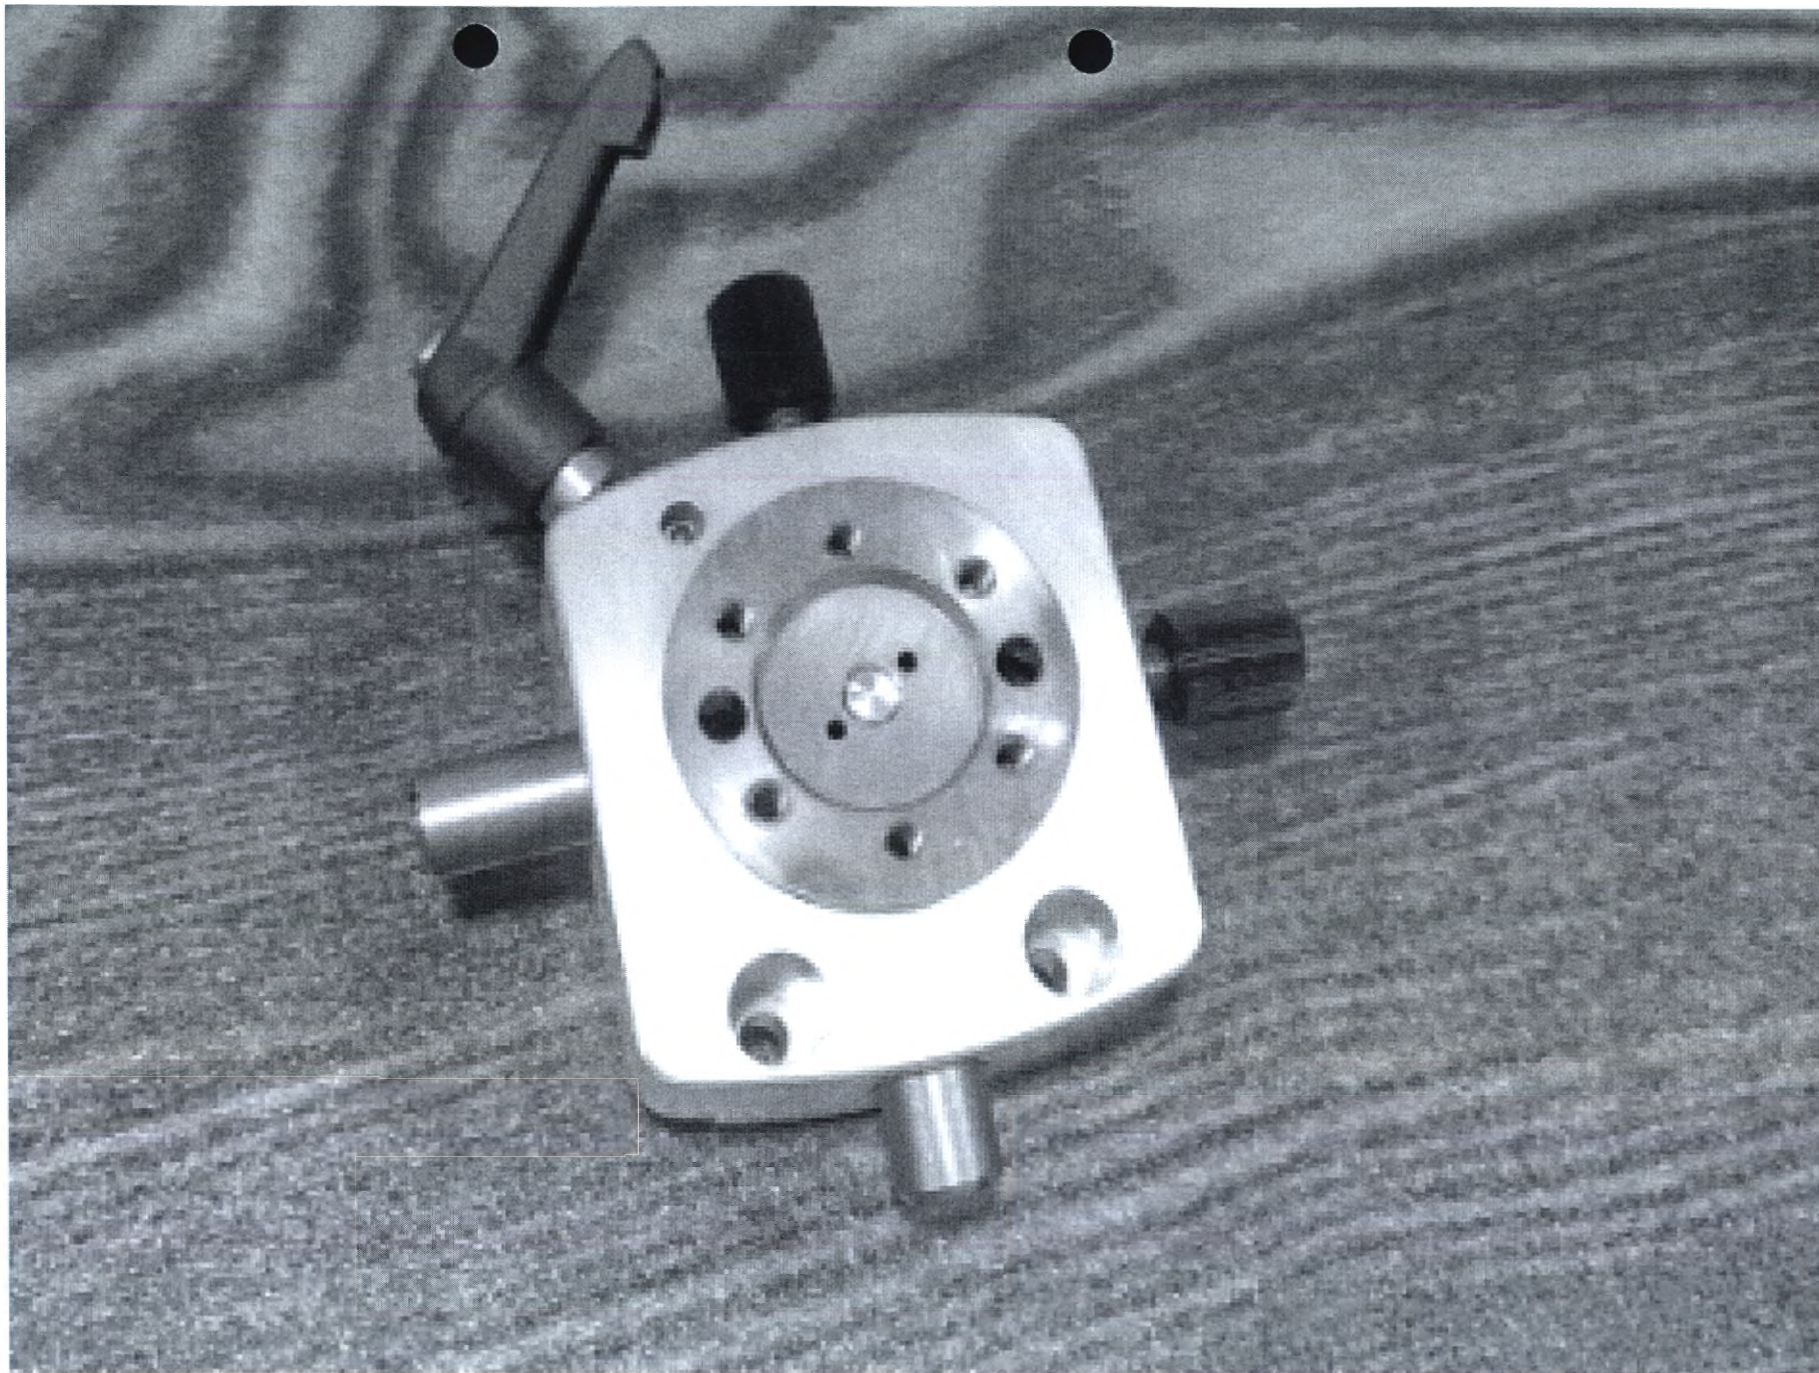


11. Крепление для быстрого зажима образца с простой ориентацией (Directional fixture for specimen clamp)

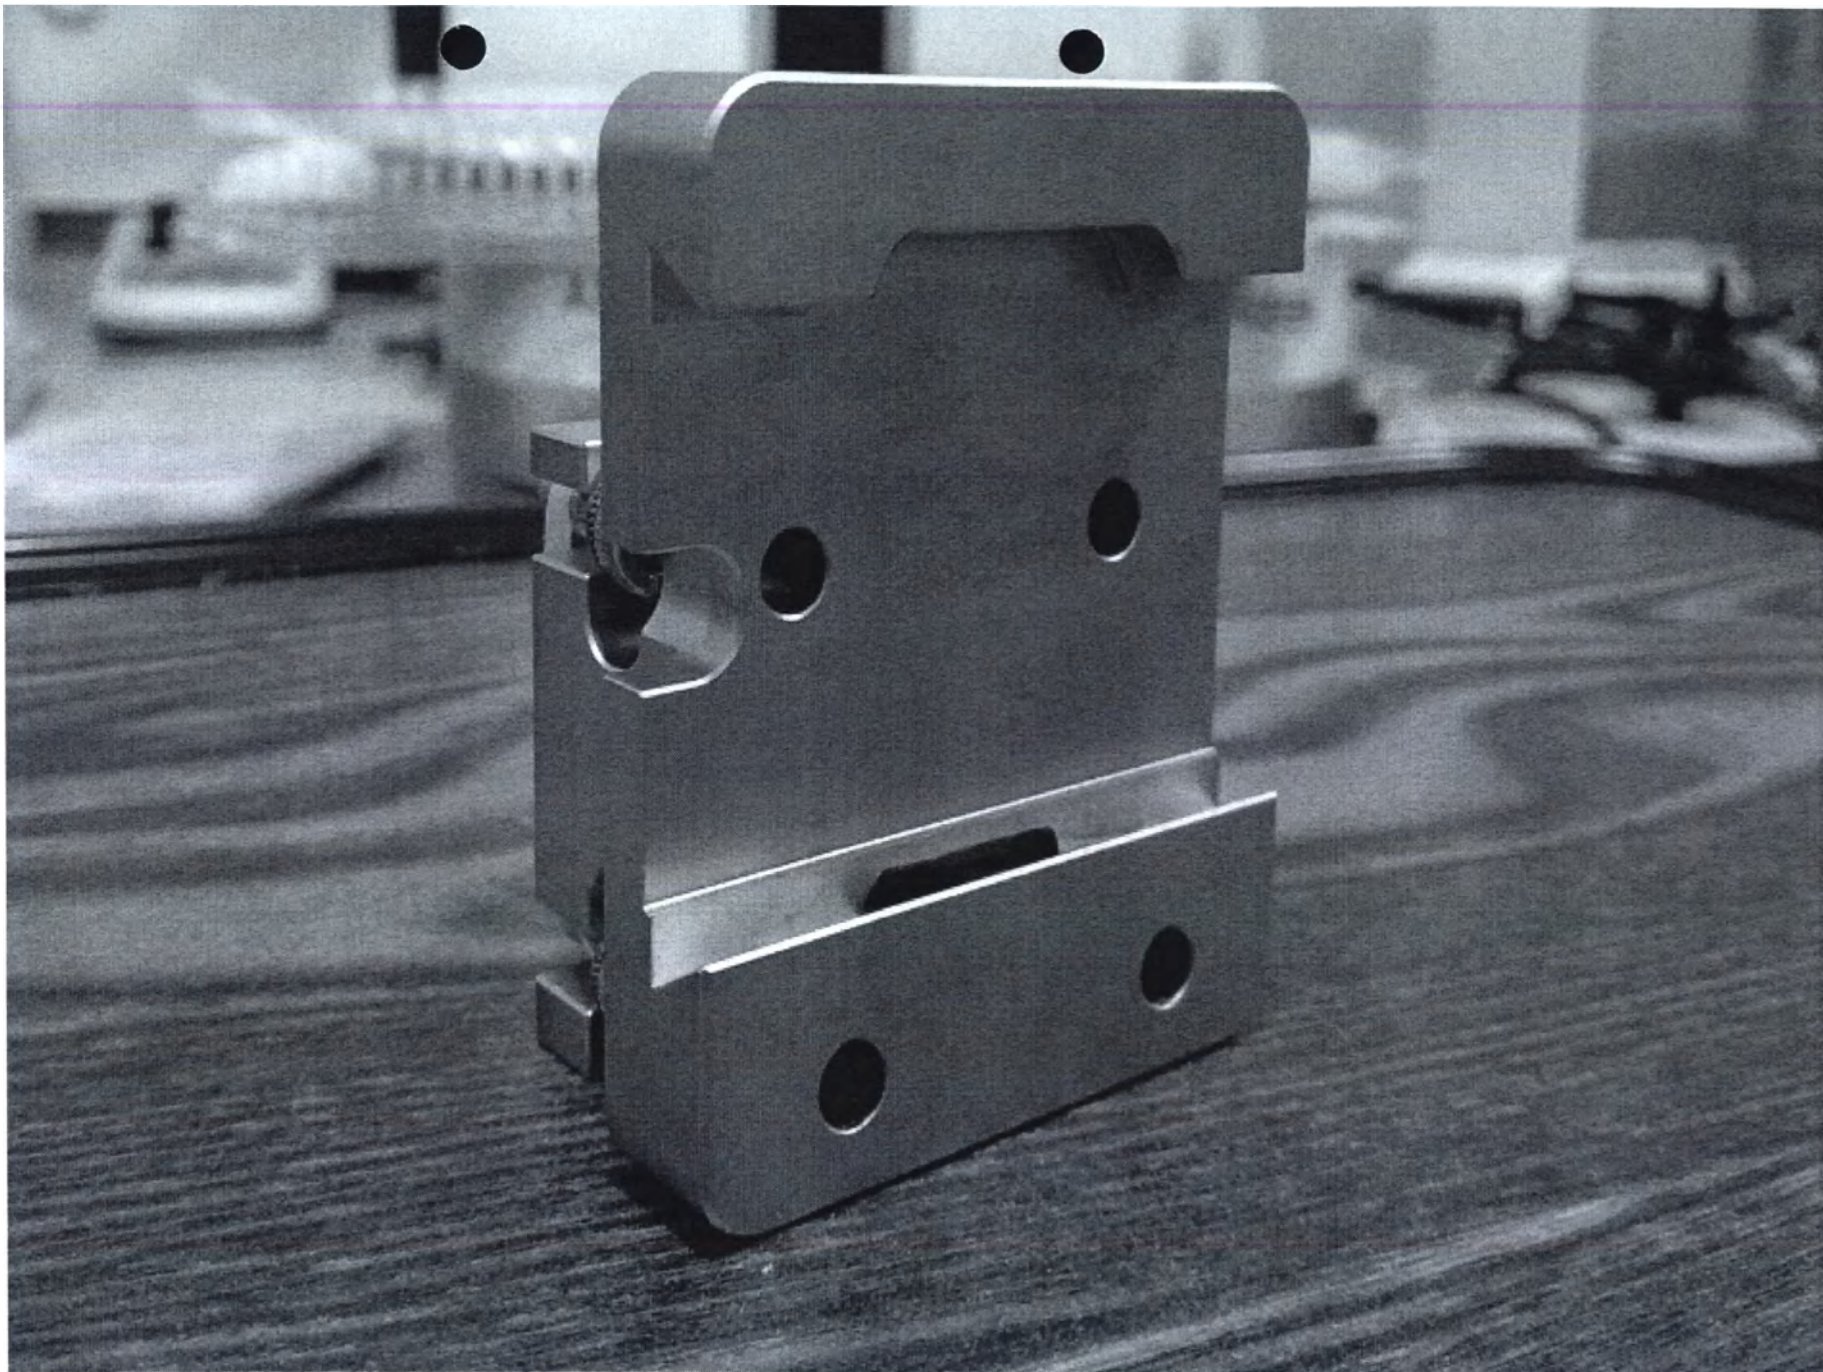


12. Жесткое крепление для зажима образца (Rigid fixture for specimen clamp)

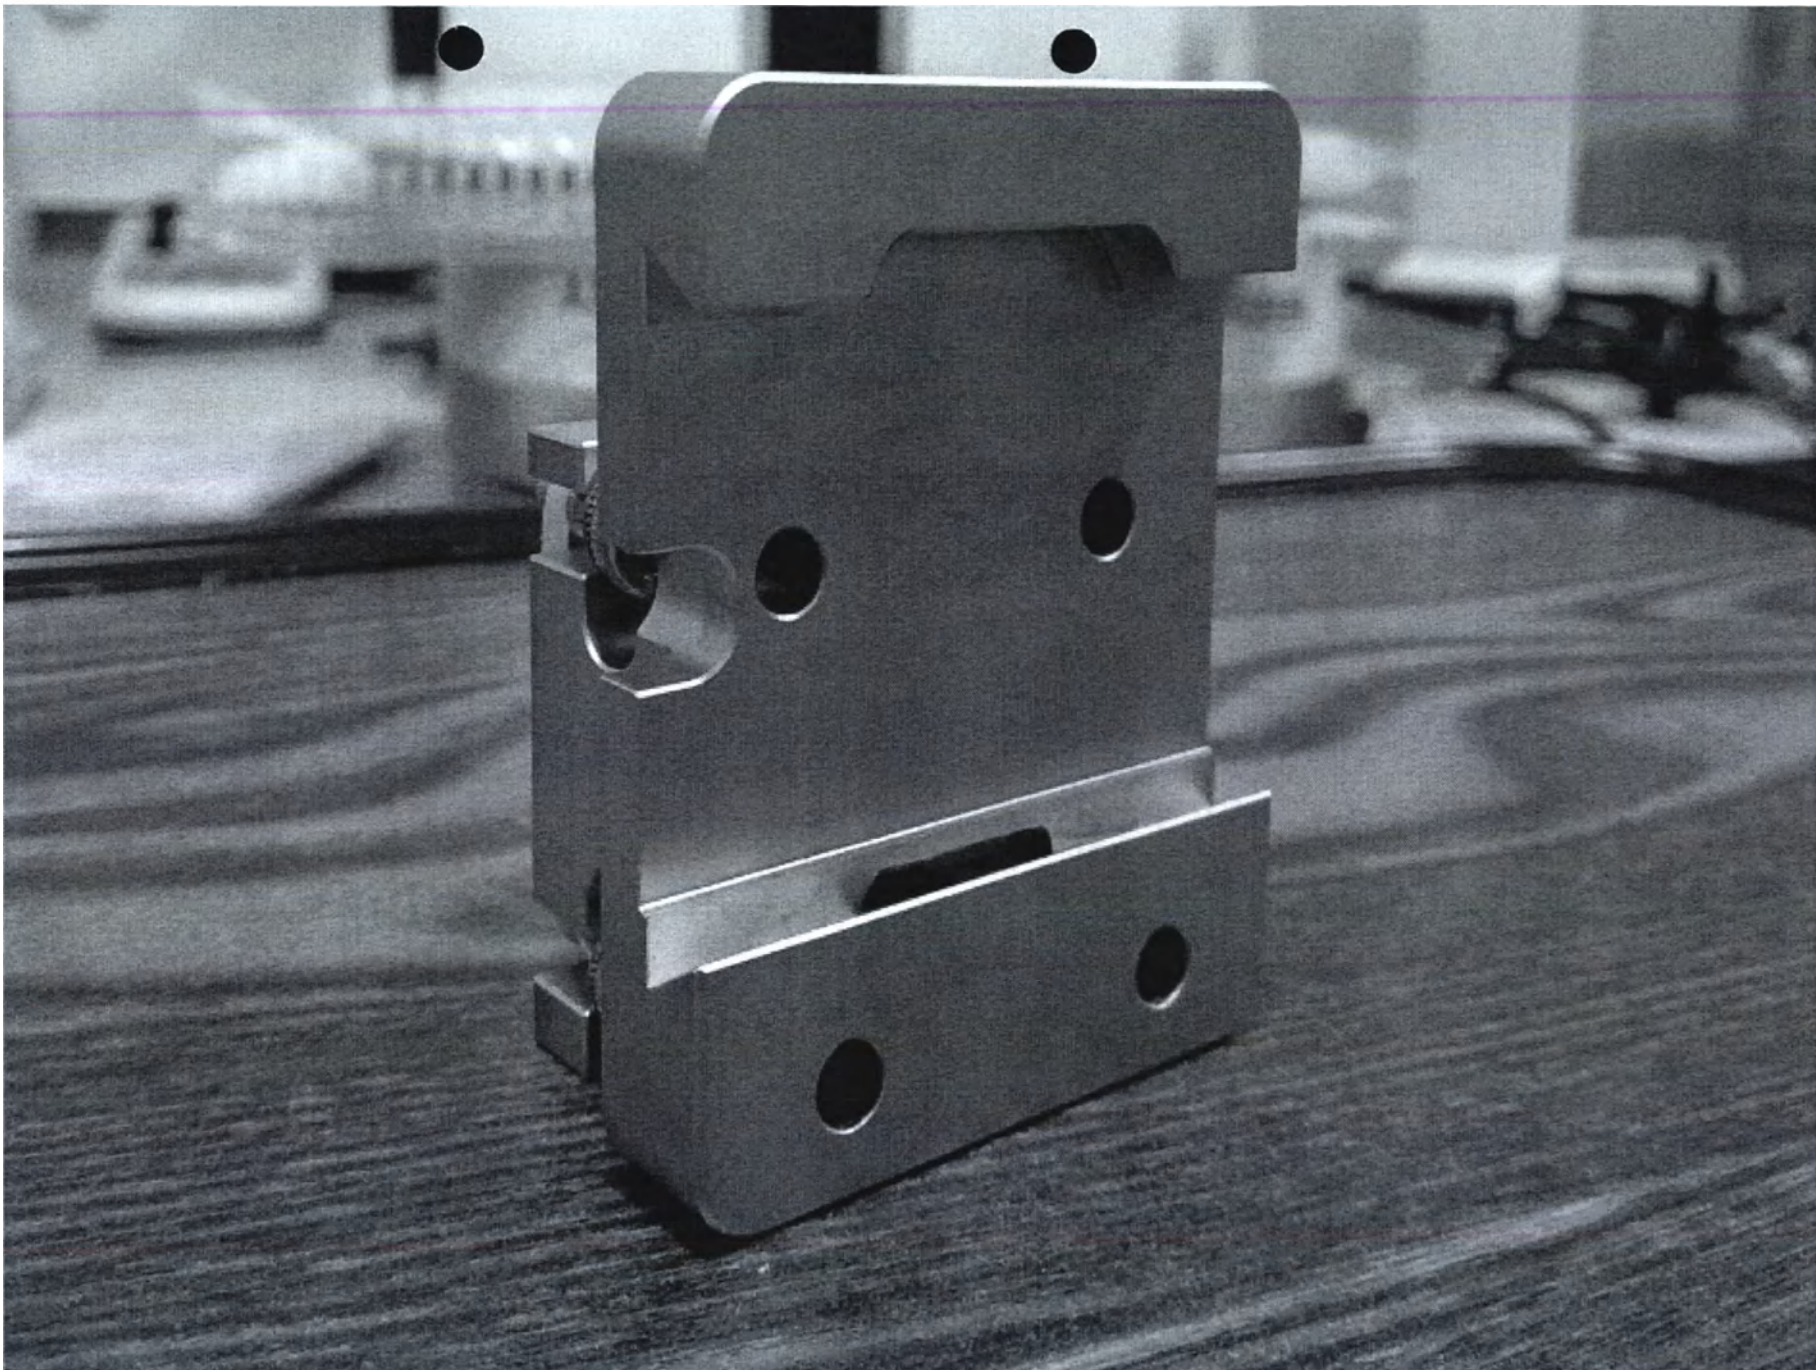


12. Жесткое крепление для зажима образца (Rigid fixture for specimen clamp)

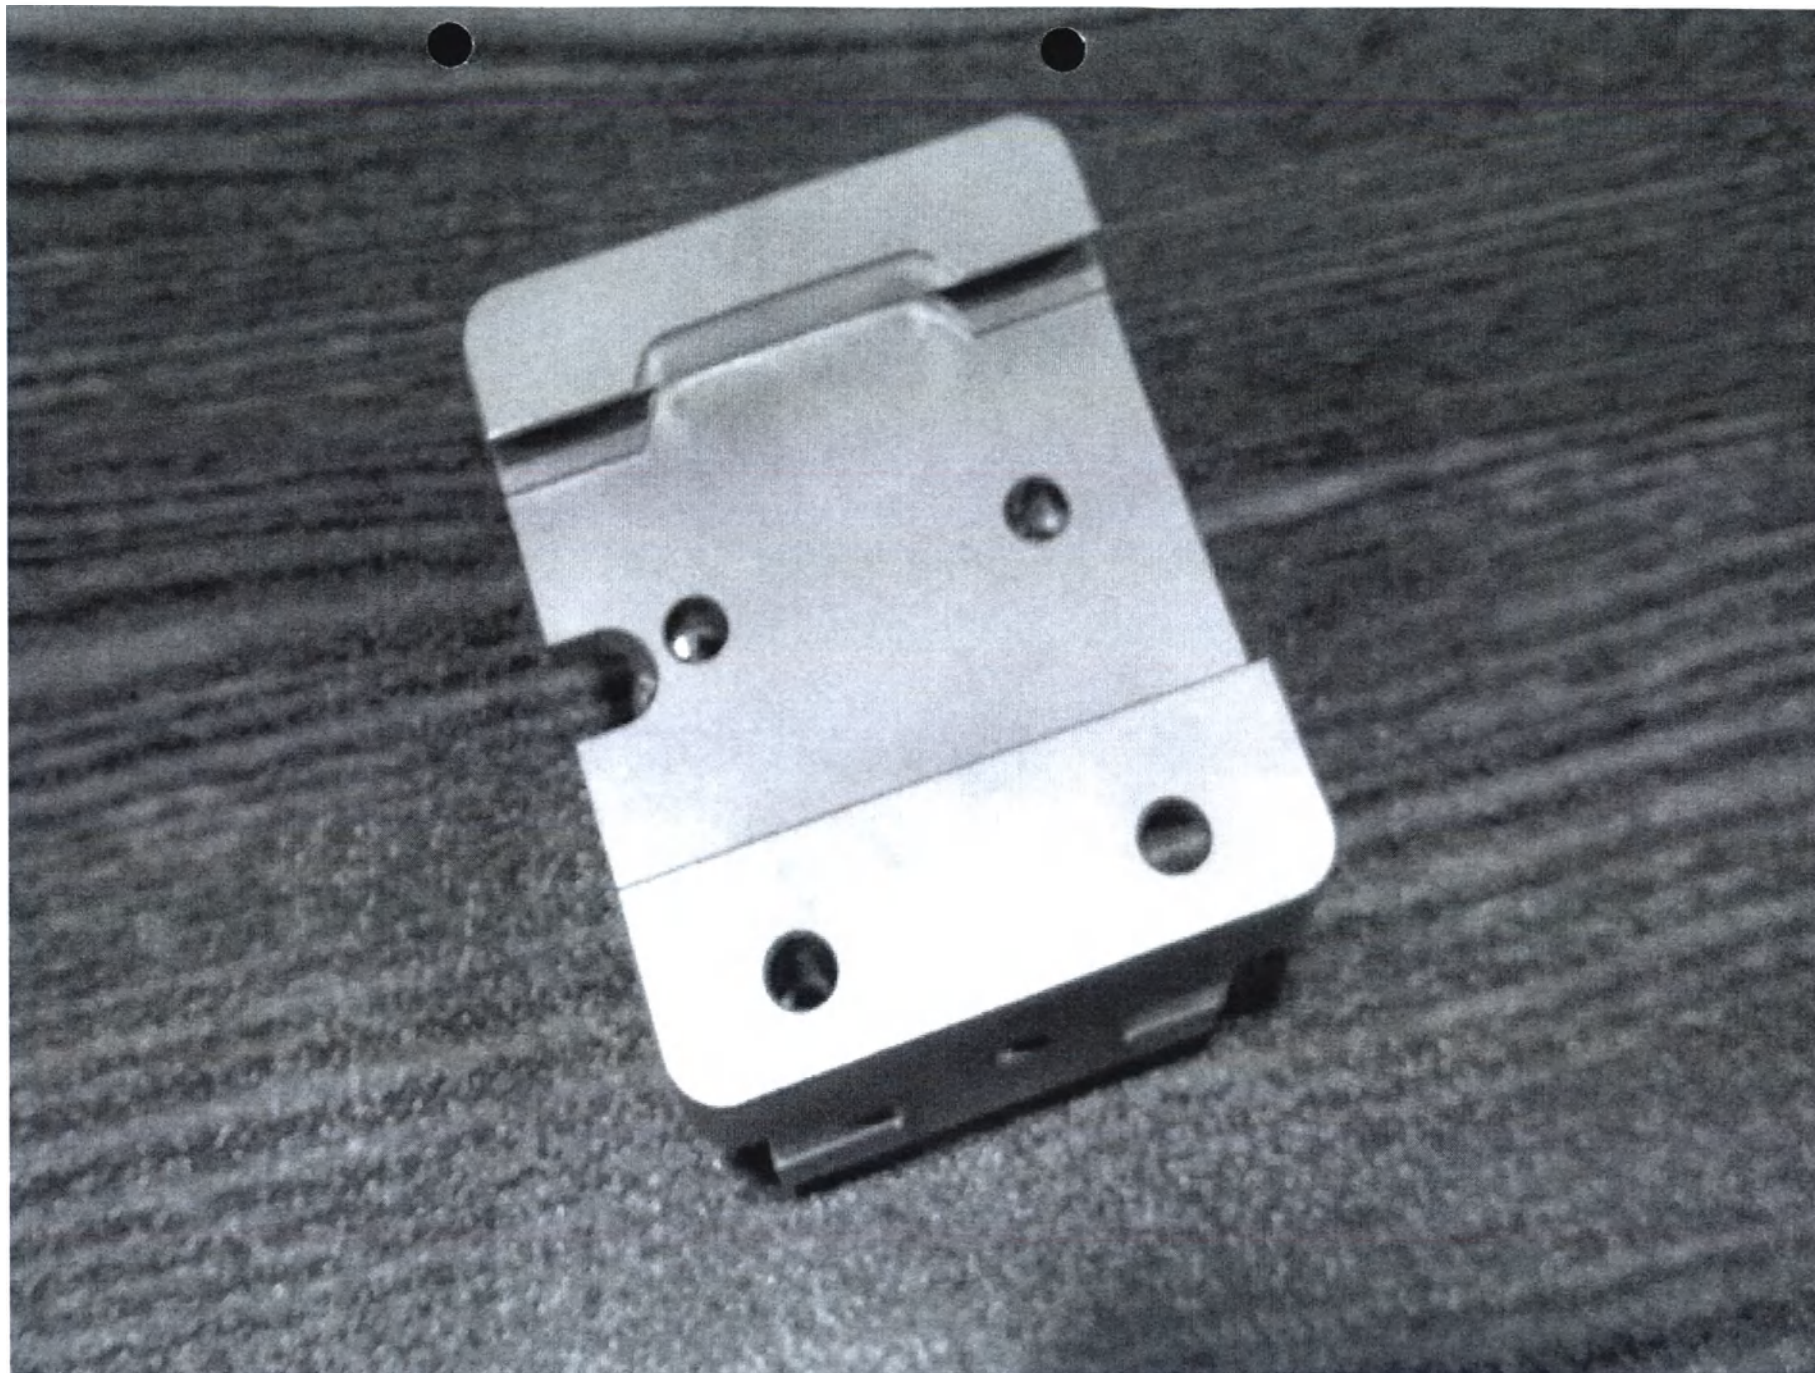


13. Система быстрого зажима образца (Quick clamping system)

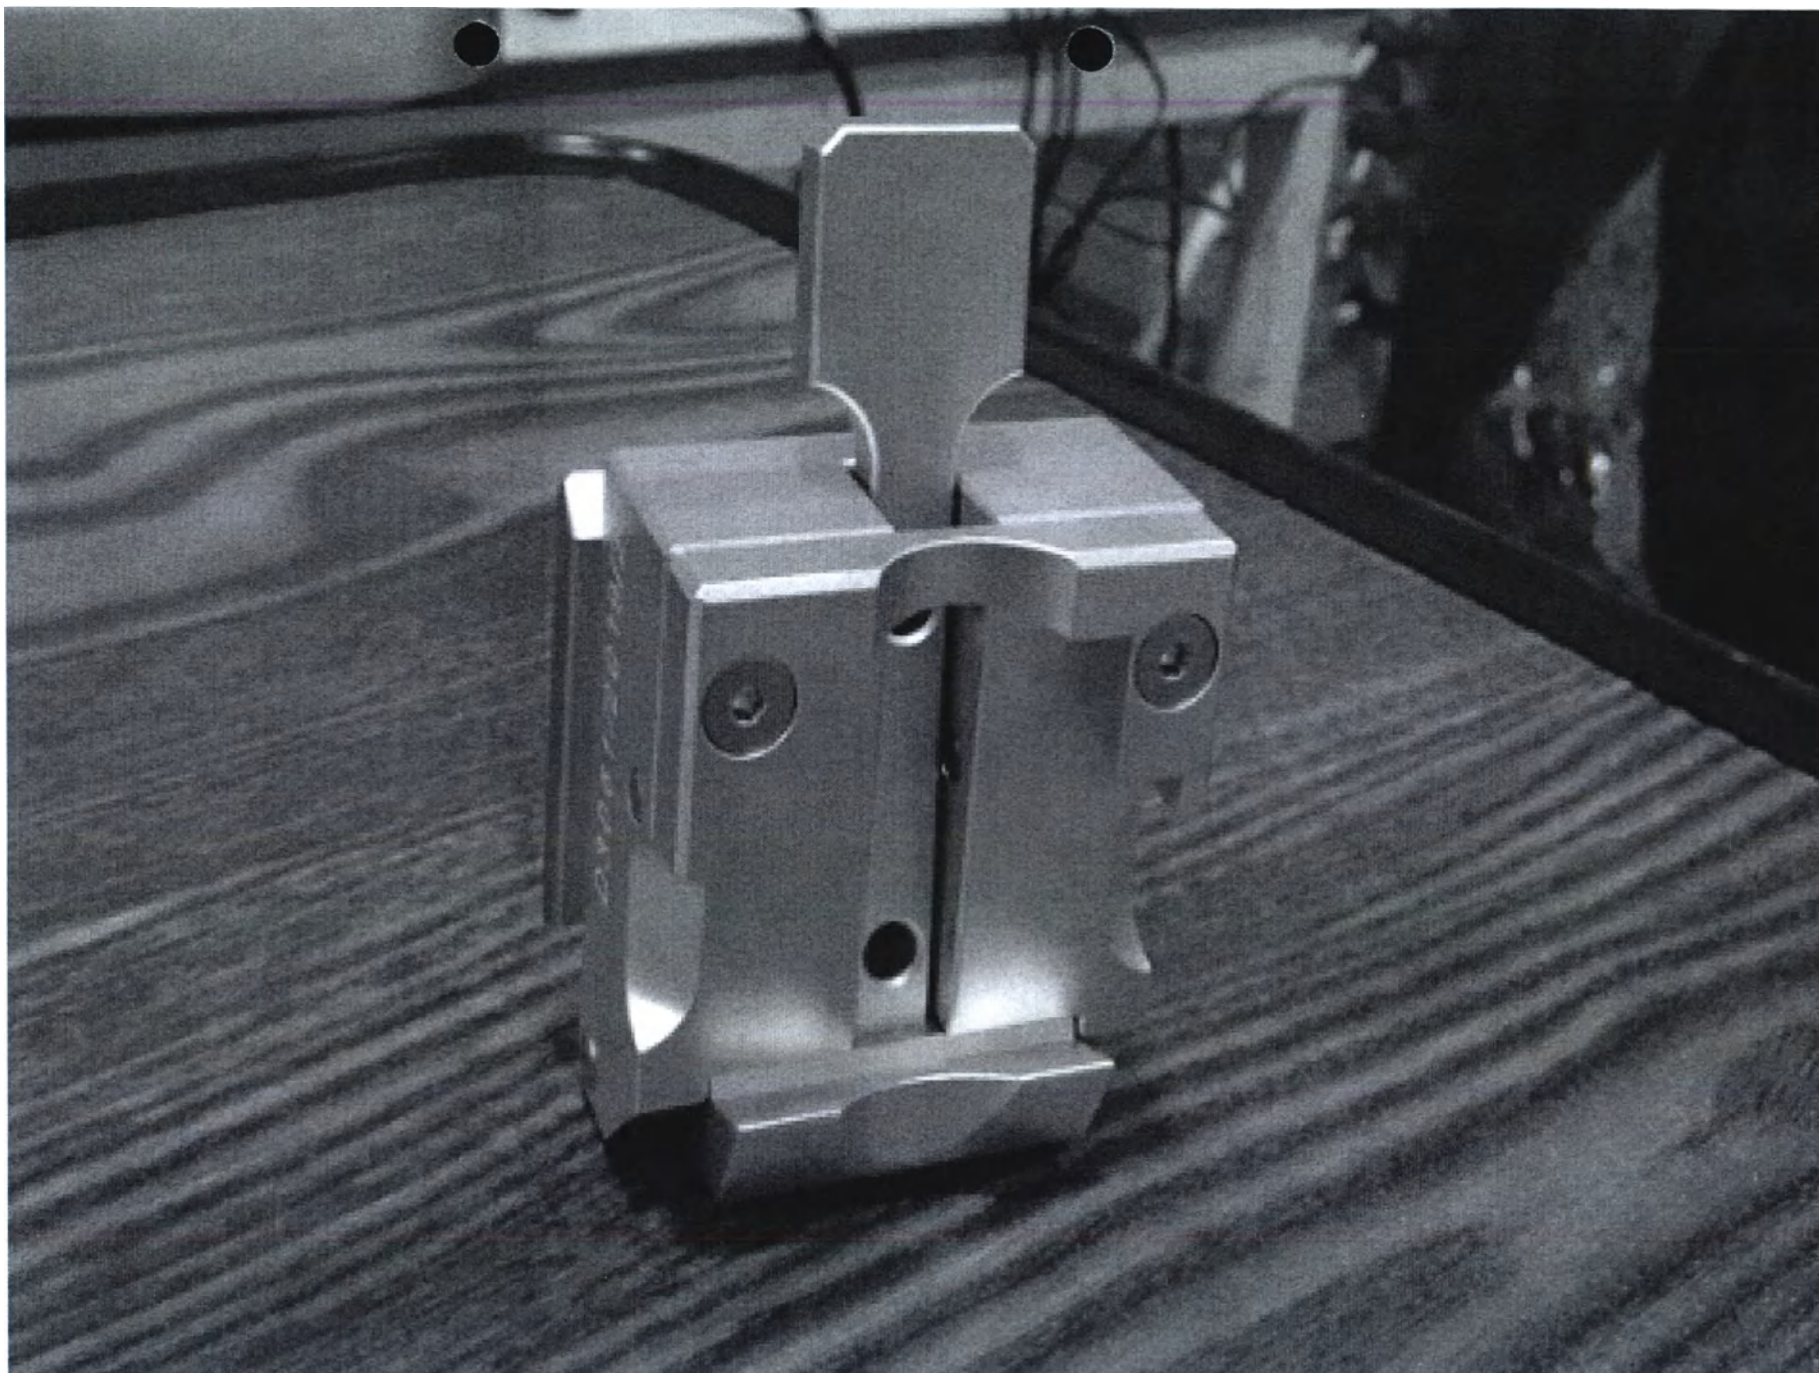

14. Зажим кассетный универсальный (Universal cassette clamp)

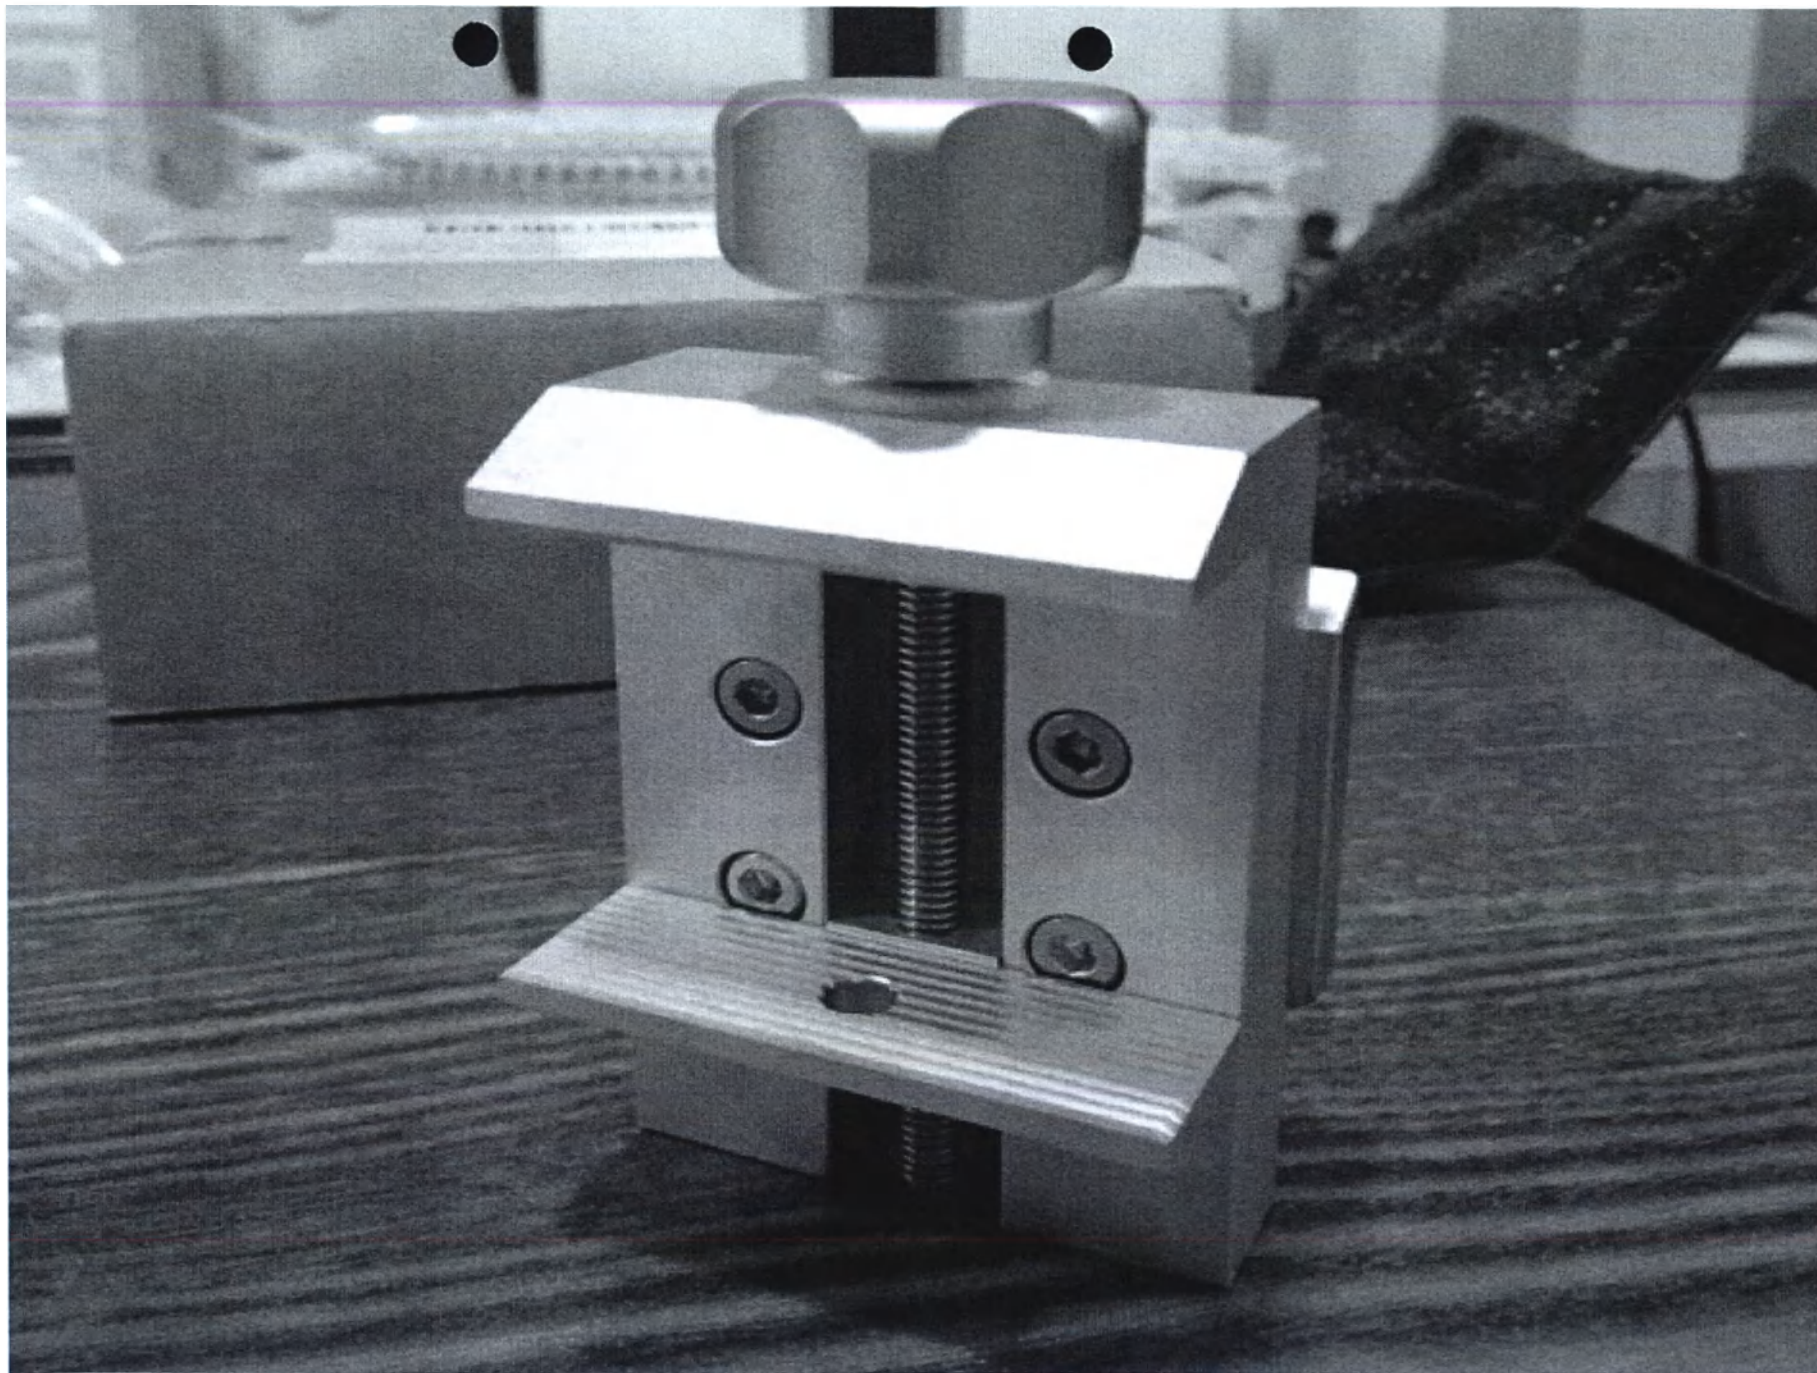


15. Зажим образца стандартный, 50 × 55 мм (Standard specimen clamp 50×55 mm)

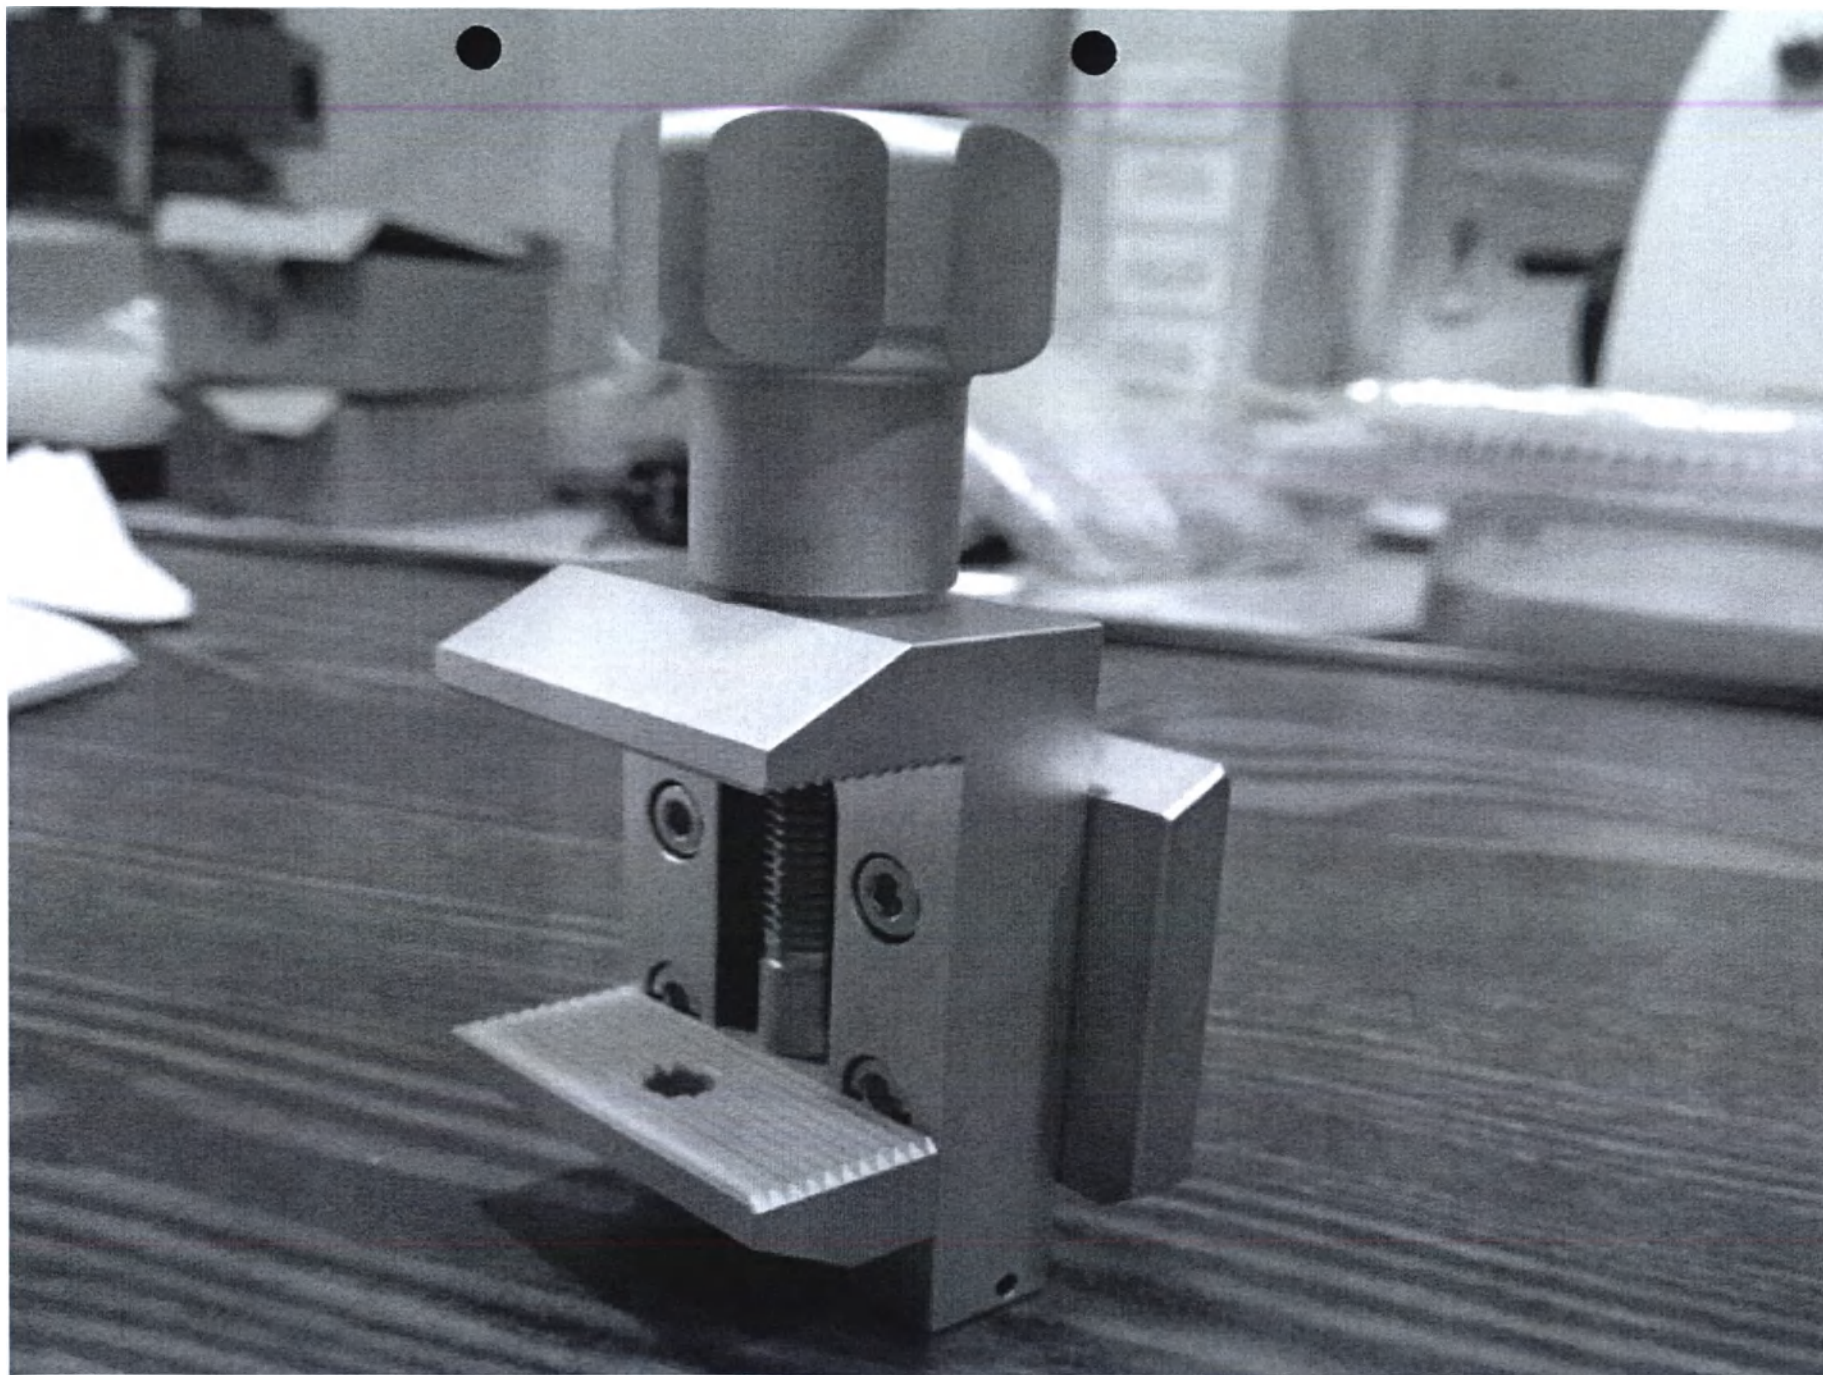


16. Зажим образца стандартный, 40 × 40 мм (Standard specimen clamp 40x40 mm)




17. Зажим кассетный «Супер» (Super cassette clamp)

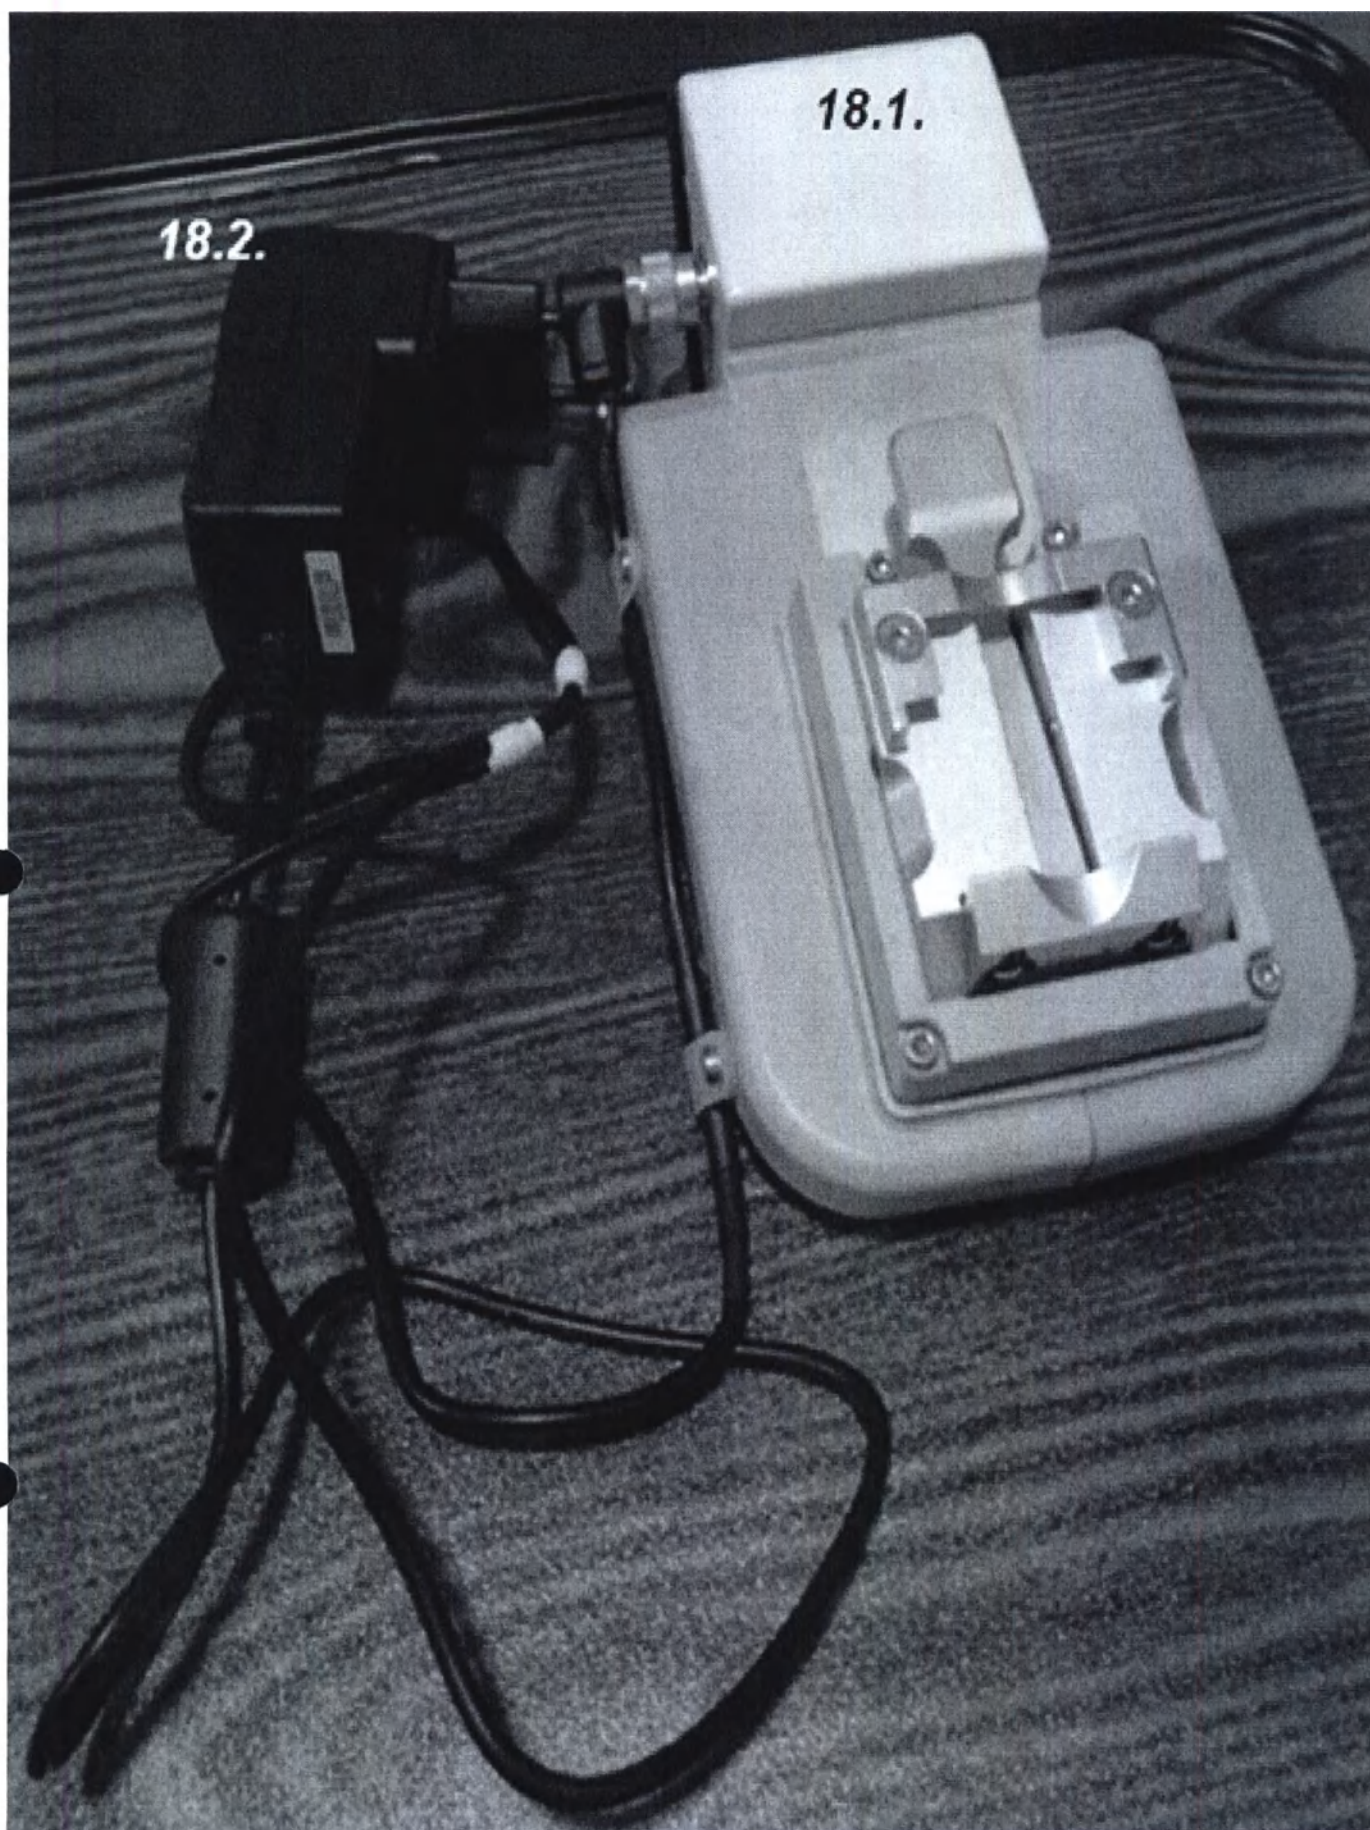


18. Зажим кассетный универсальный с охлаждением CoolClamp (RM CoolClamp), в составе: 18.1. Зажим кассетный универсальный с охлаждением CoolClamp (RM CoolClamp); 18.2. Блок питания (Power supply)

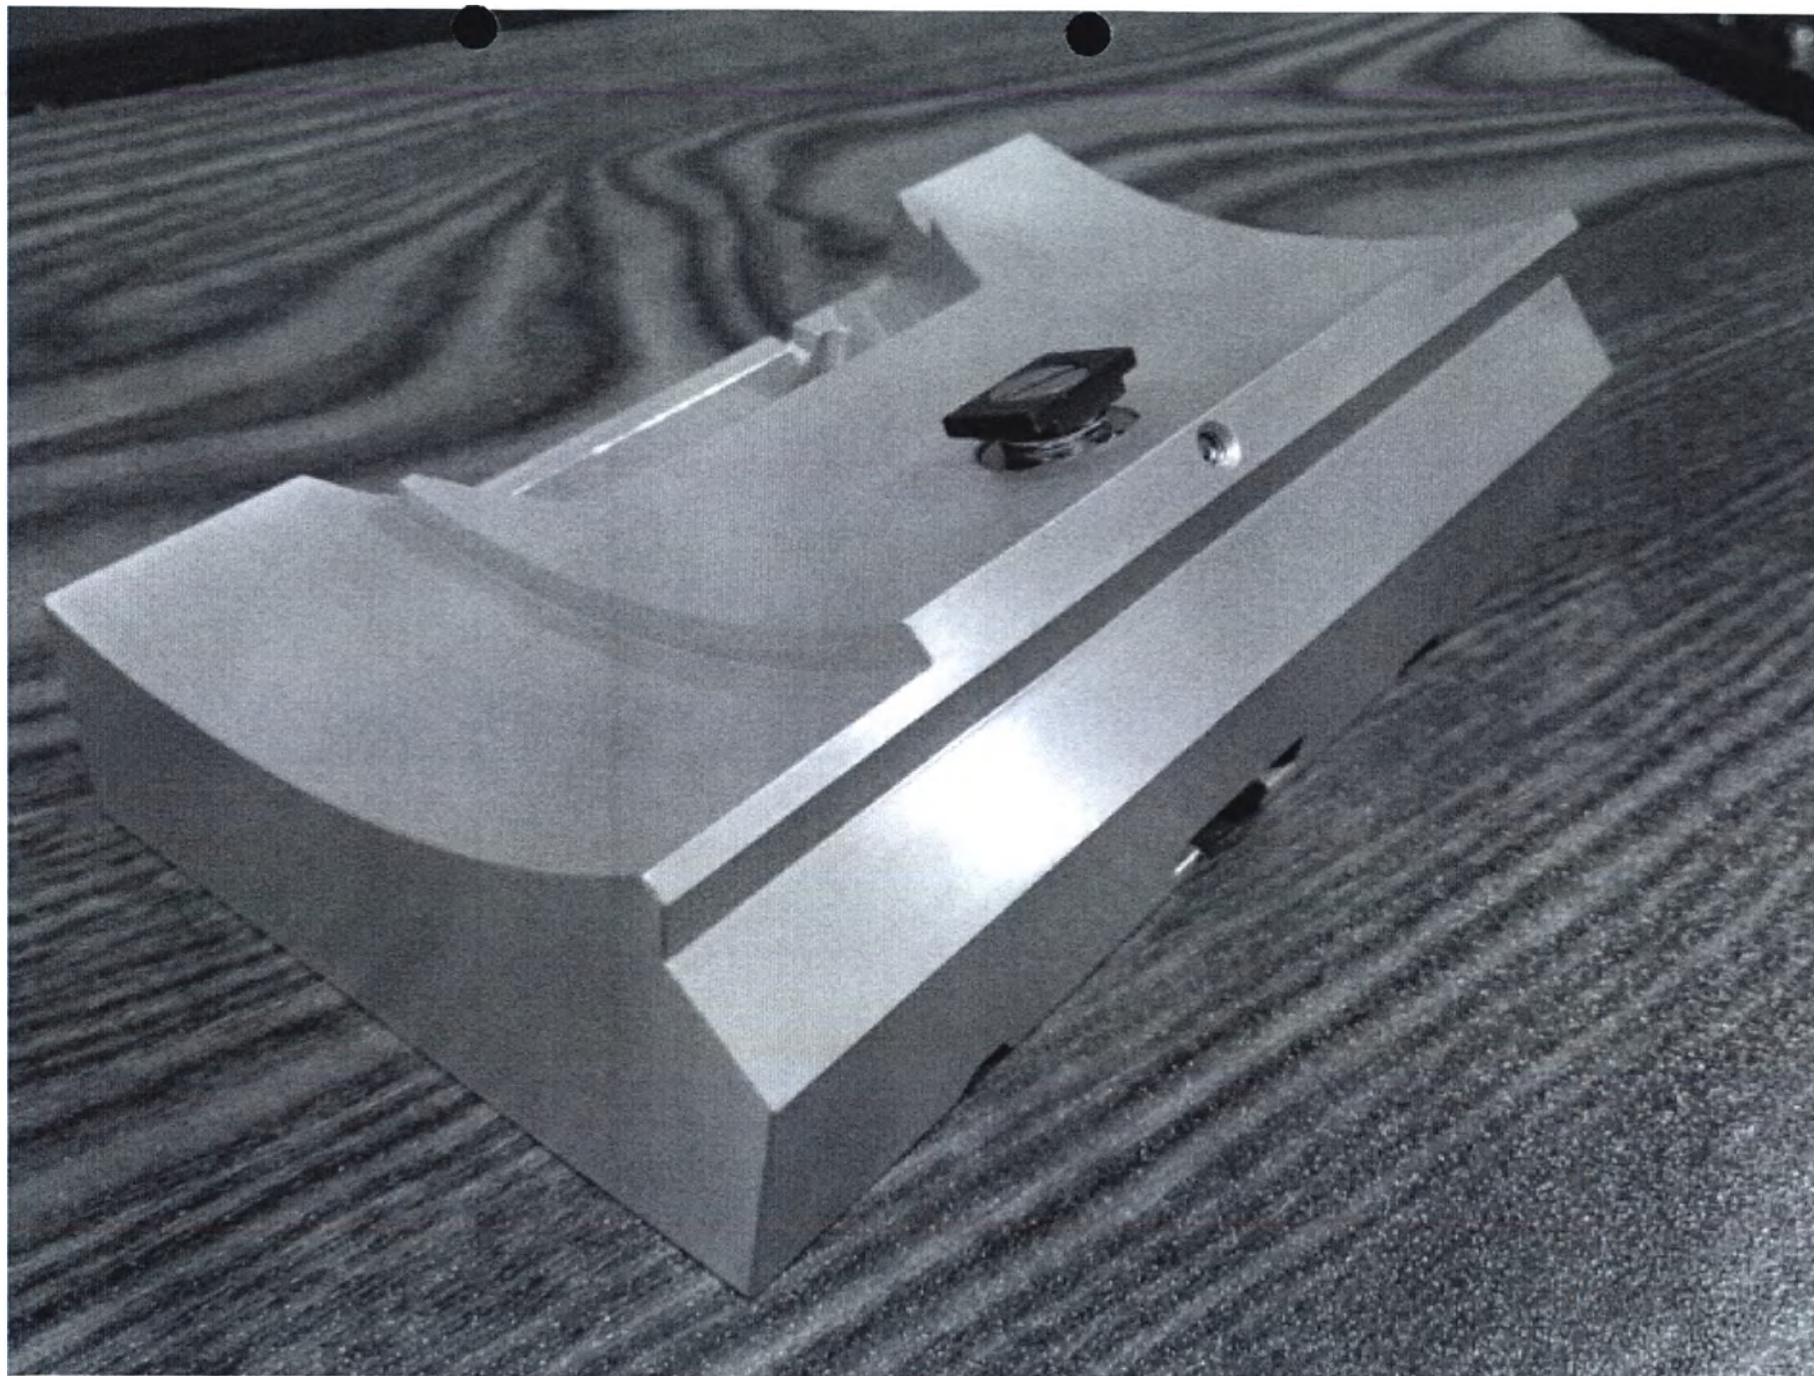


19. Основание держателя лезвия (Blade holder base)

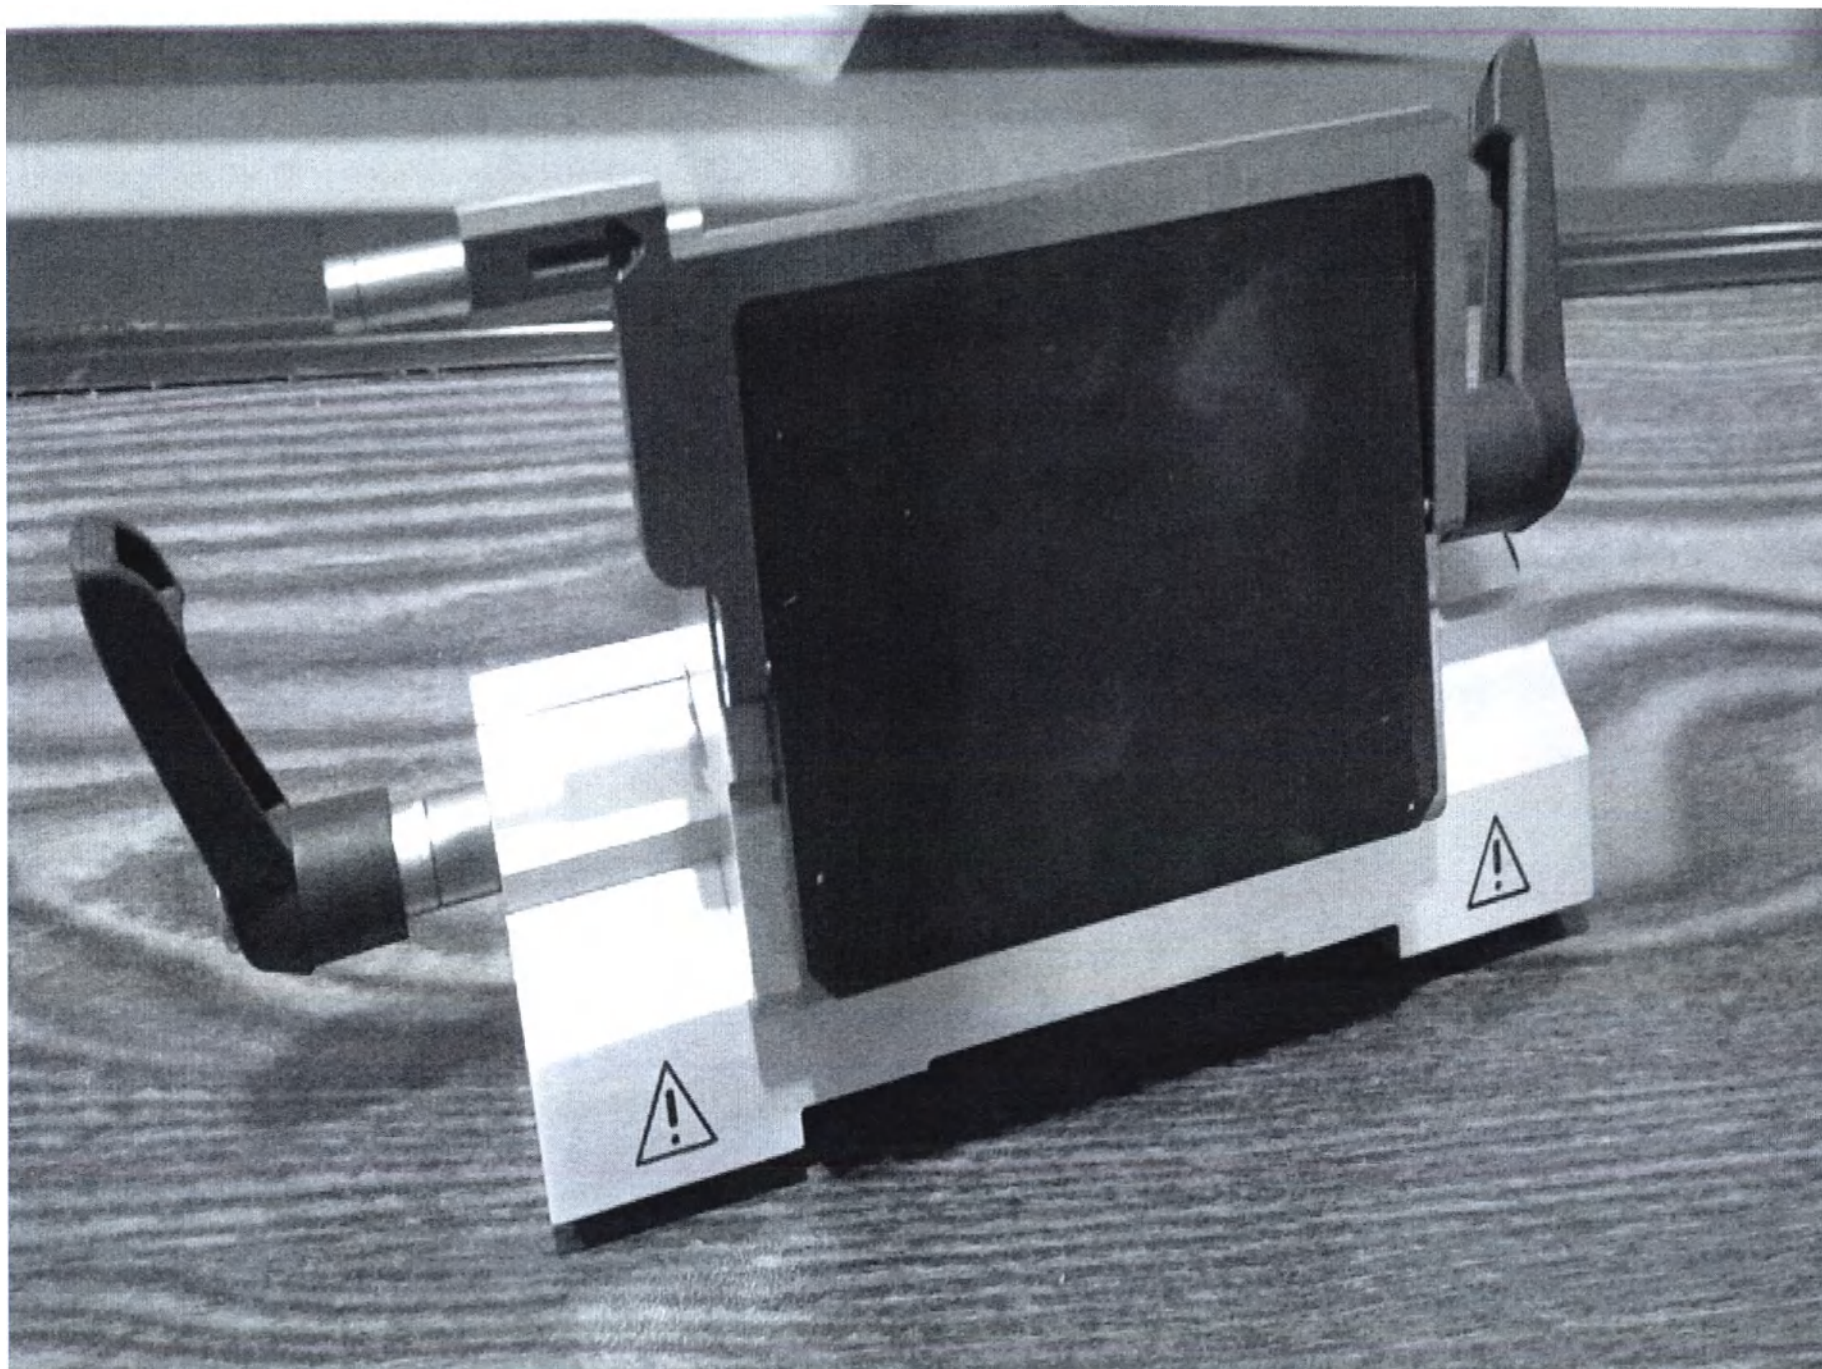


20. Держатель лезвия универсальный Е (2-in-1 Blade holder E)

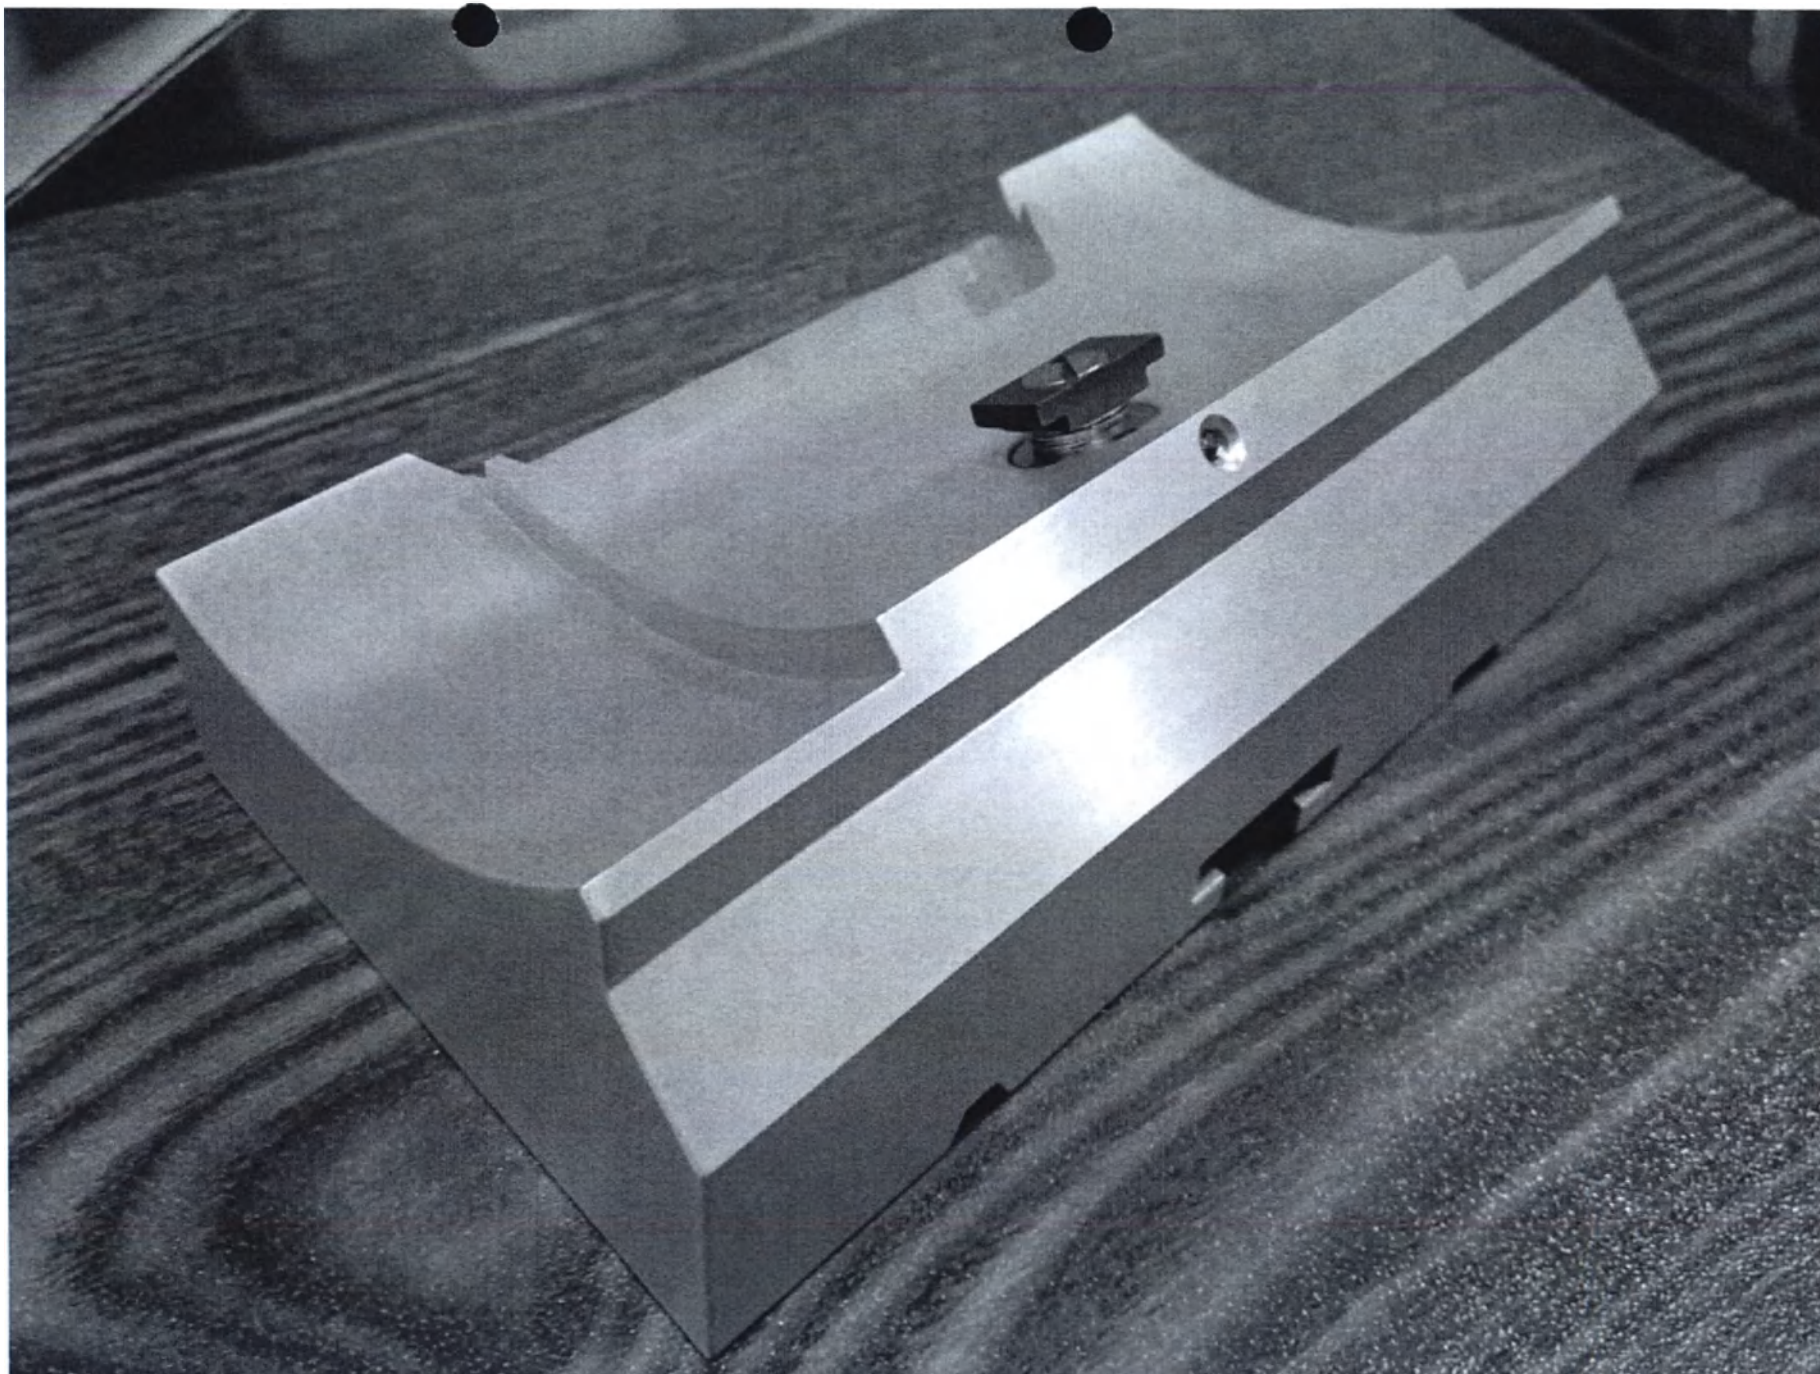

21. Основание держателя ножа (Knife holder base)

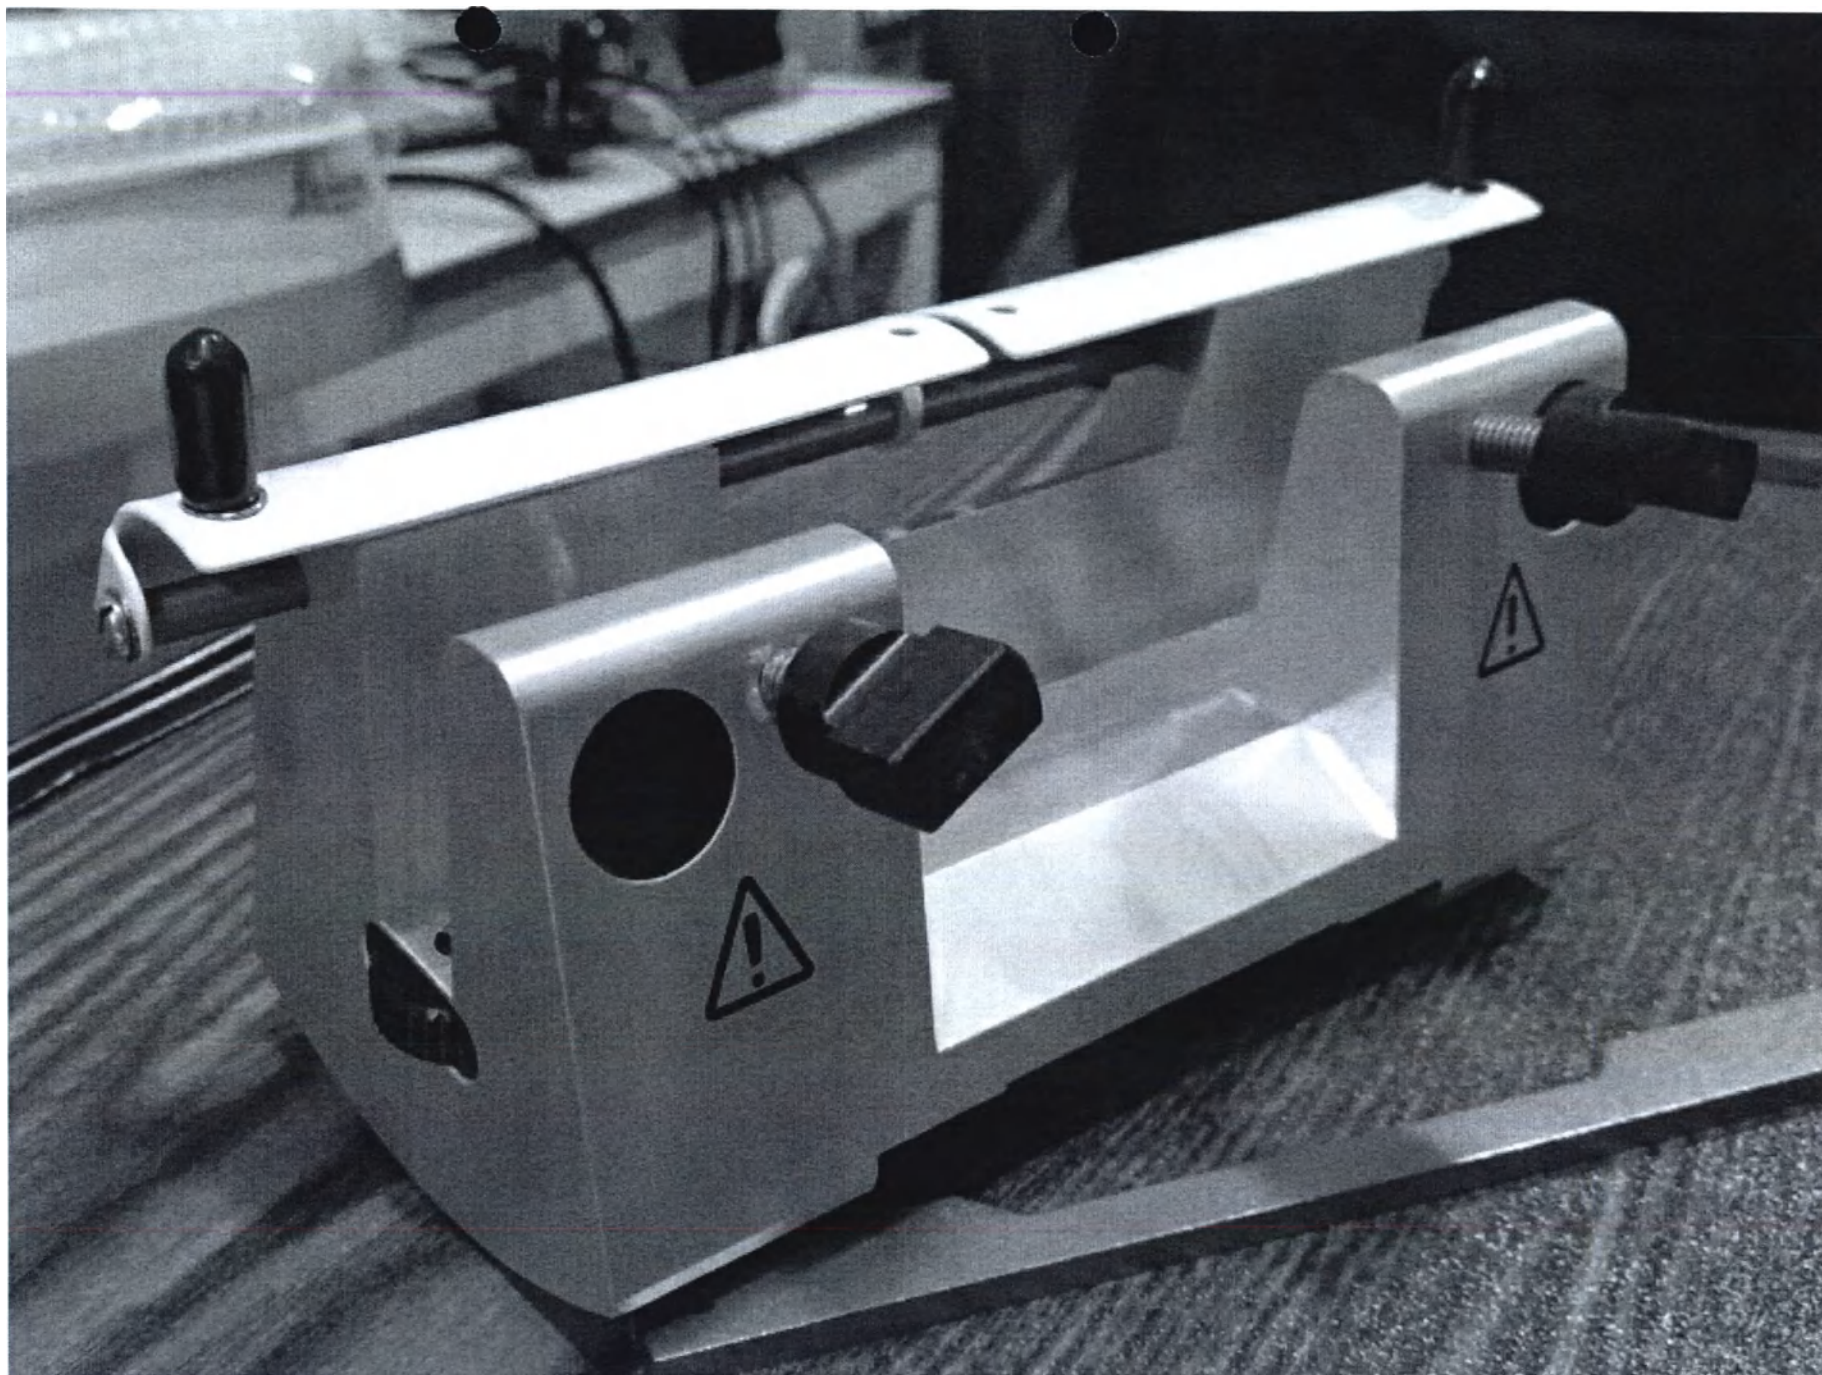

22. Держатель ножа N (Knife holder N)

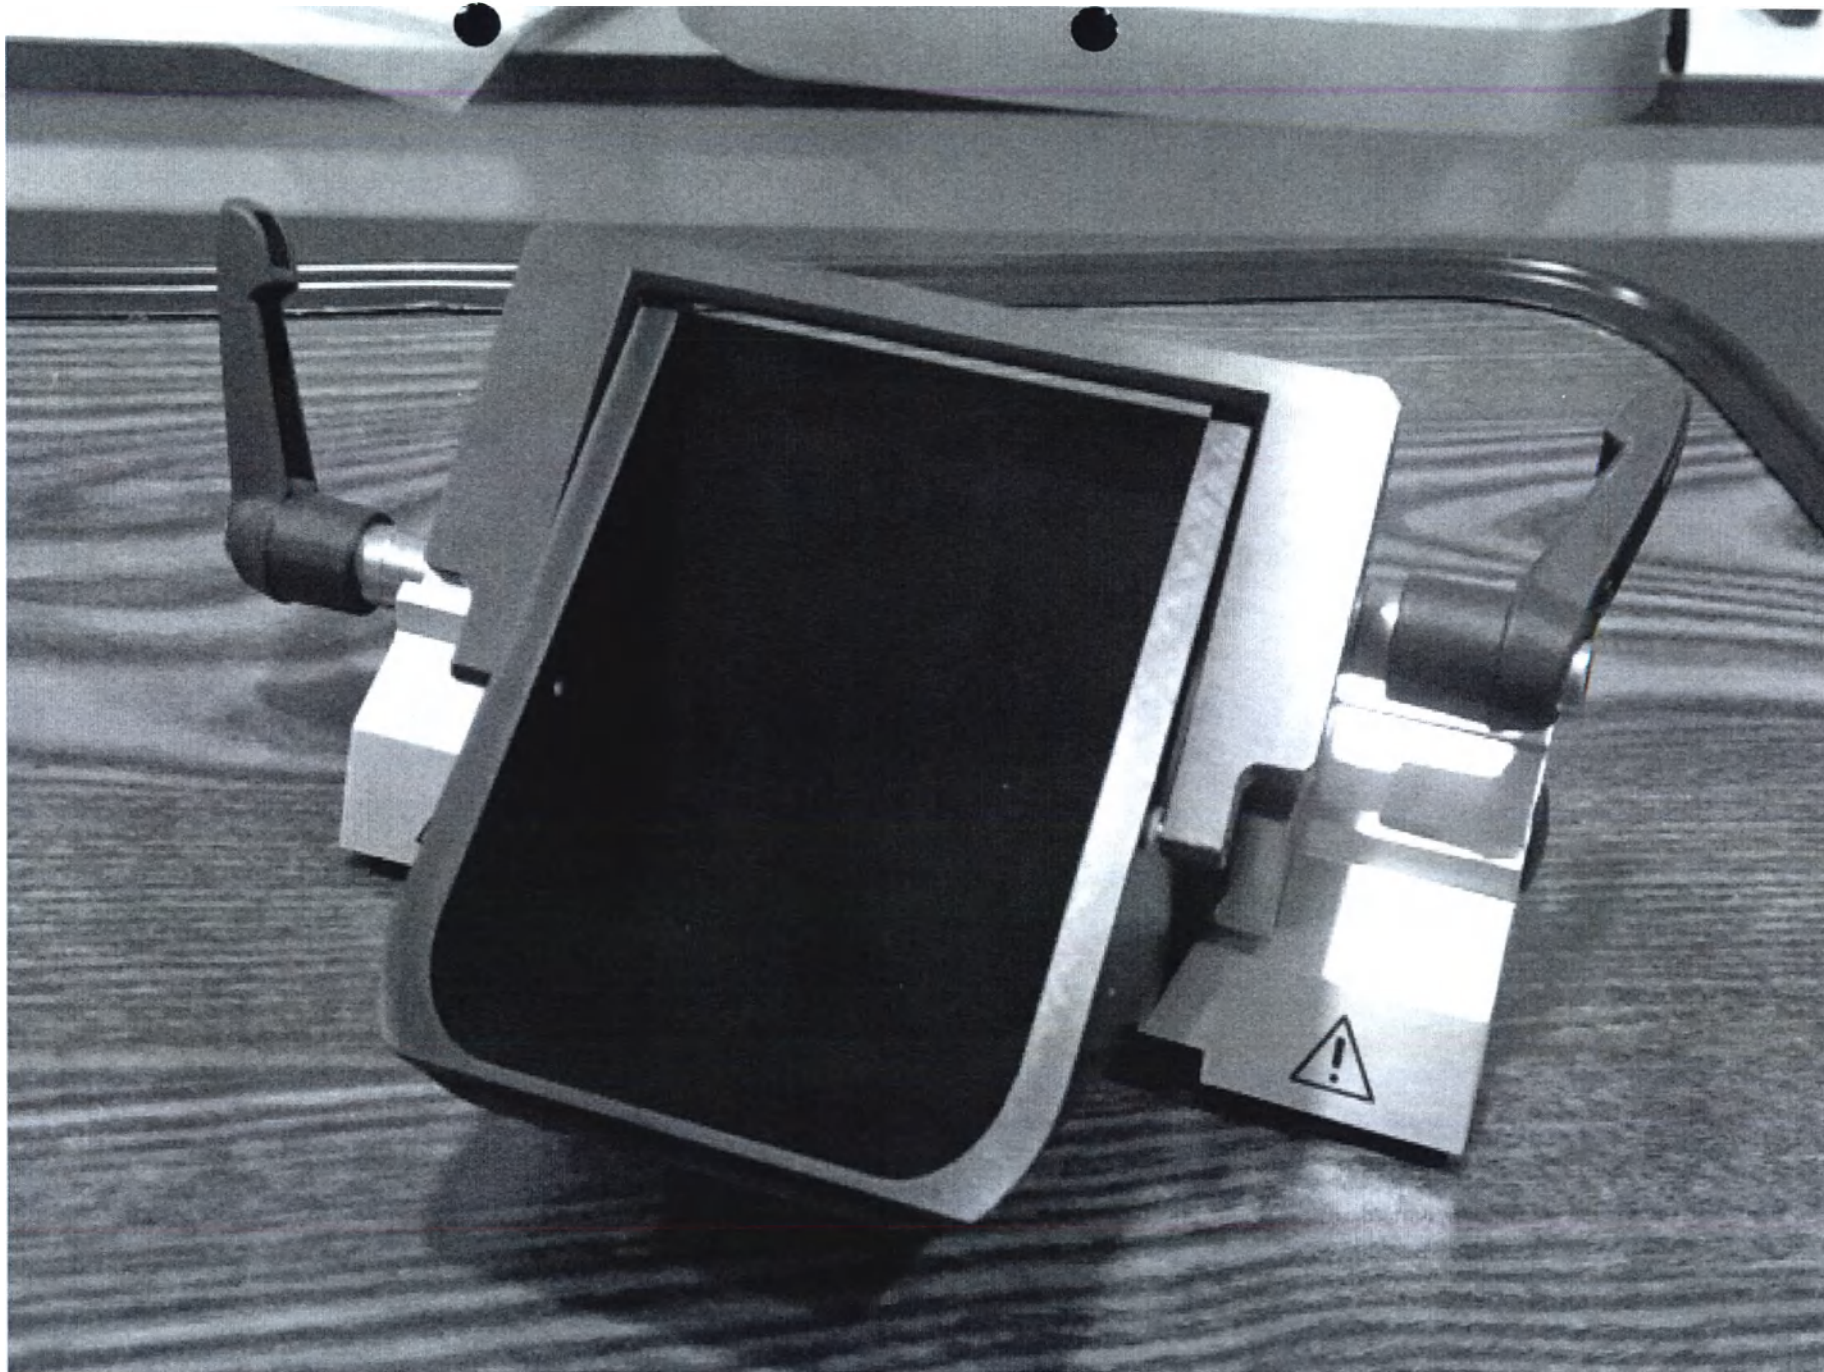

23. Держатель ножа Е с ванночкой, для лезвий низкого профиля (Knife holder E w/trough low-profile)



24. Лезвия одноразовые — низкого профиля (80 × 8 × 0,25 мм) (Disposable blades – low-profile)





24. Лезвия одноразовые — низкого профиля (80 × 8 × 0,25 мм) (Disposable blades – low-profile)




25. Лезвия одноразовые — высокого профиля (80 × 14 × 0,35 мм) (Disposable blades – high-profile)



26. Нож стальной длиной 16 см, профиль "с" (Knife 16 cm - profile c – steel)

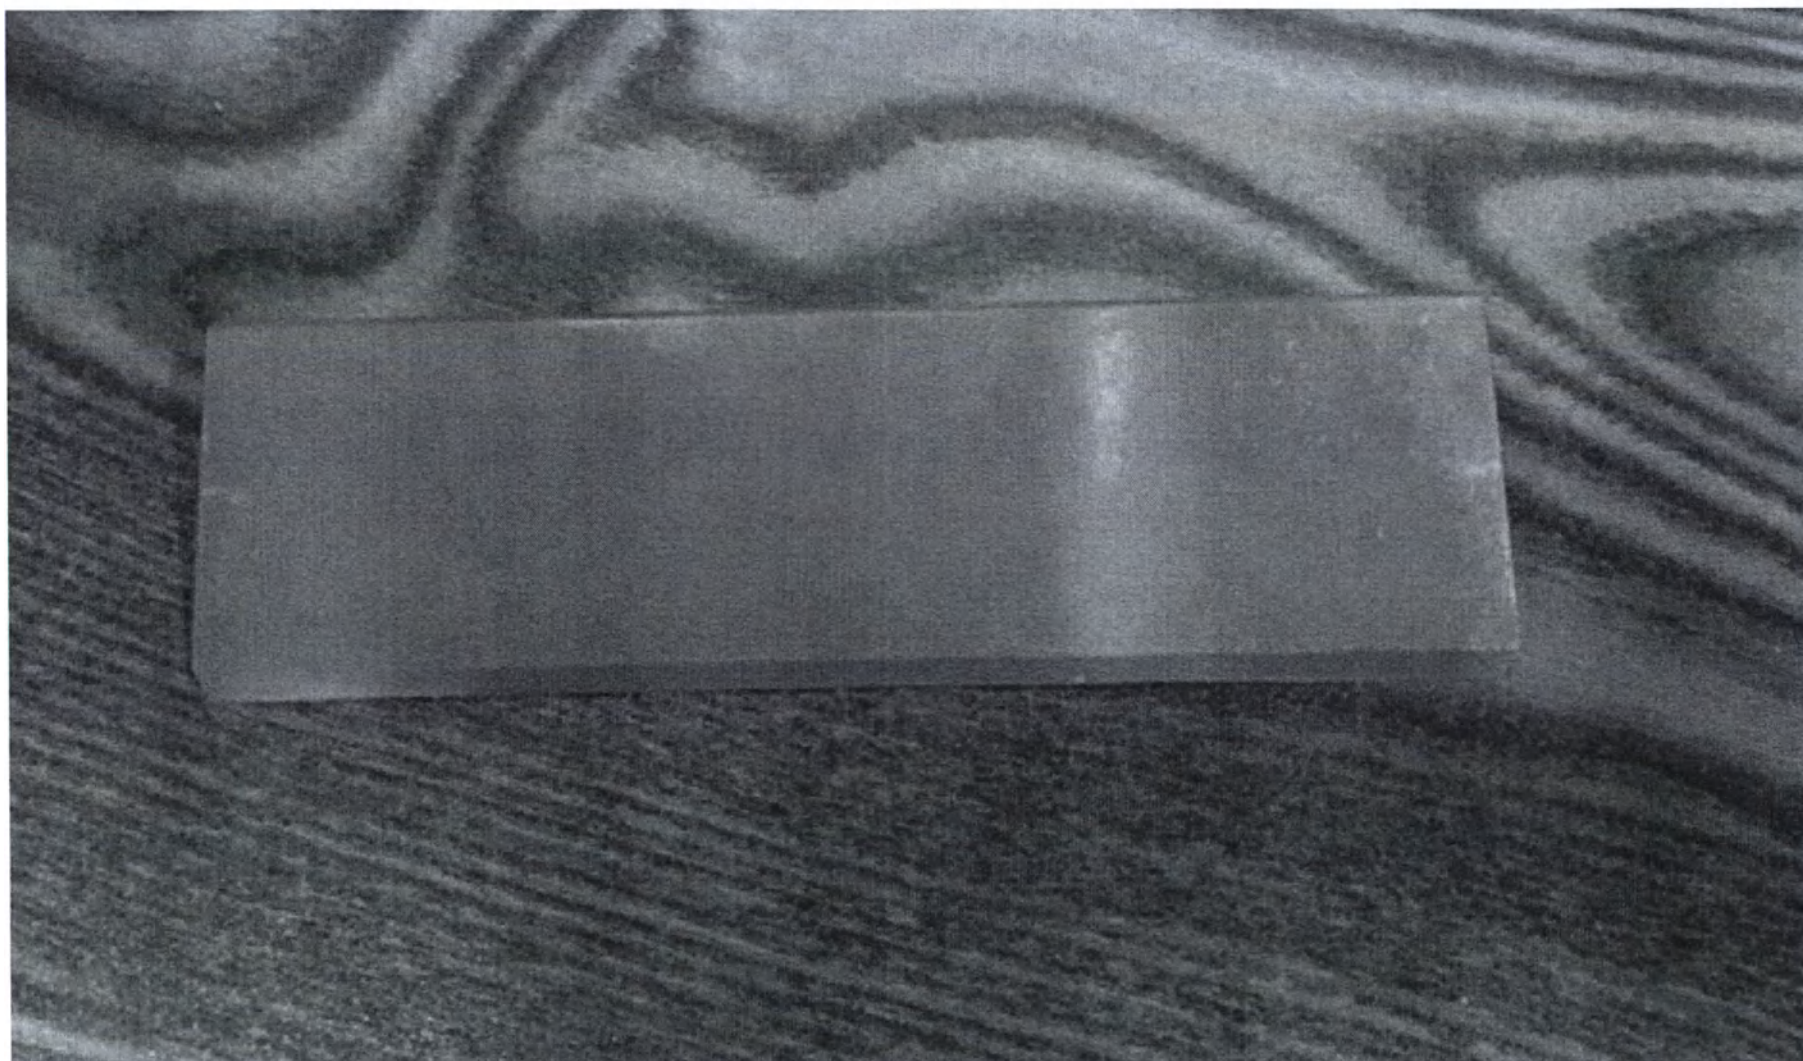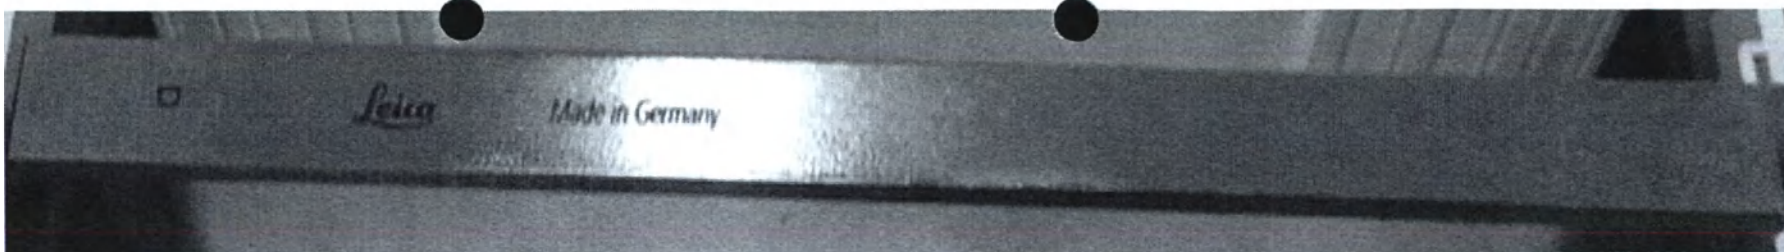

27. Нож стальной длиной 16 см, профиль "d" (Knife 16 cm - profile d – steel)

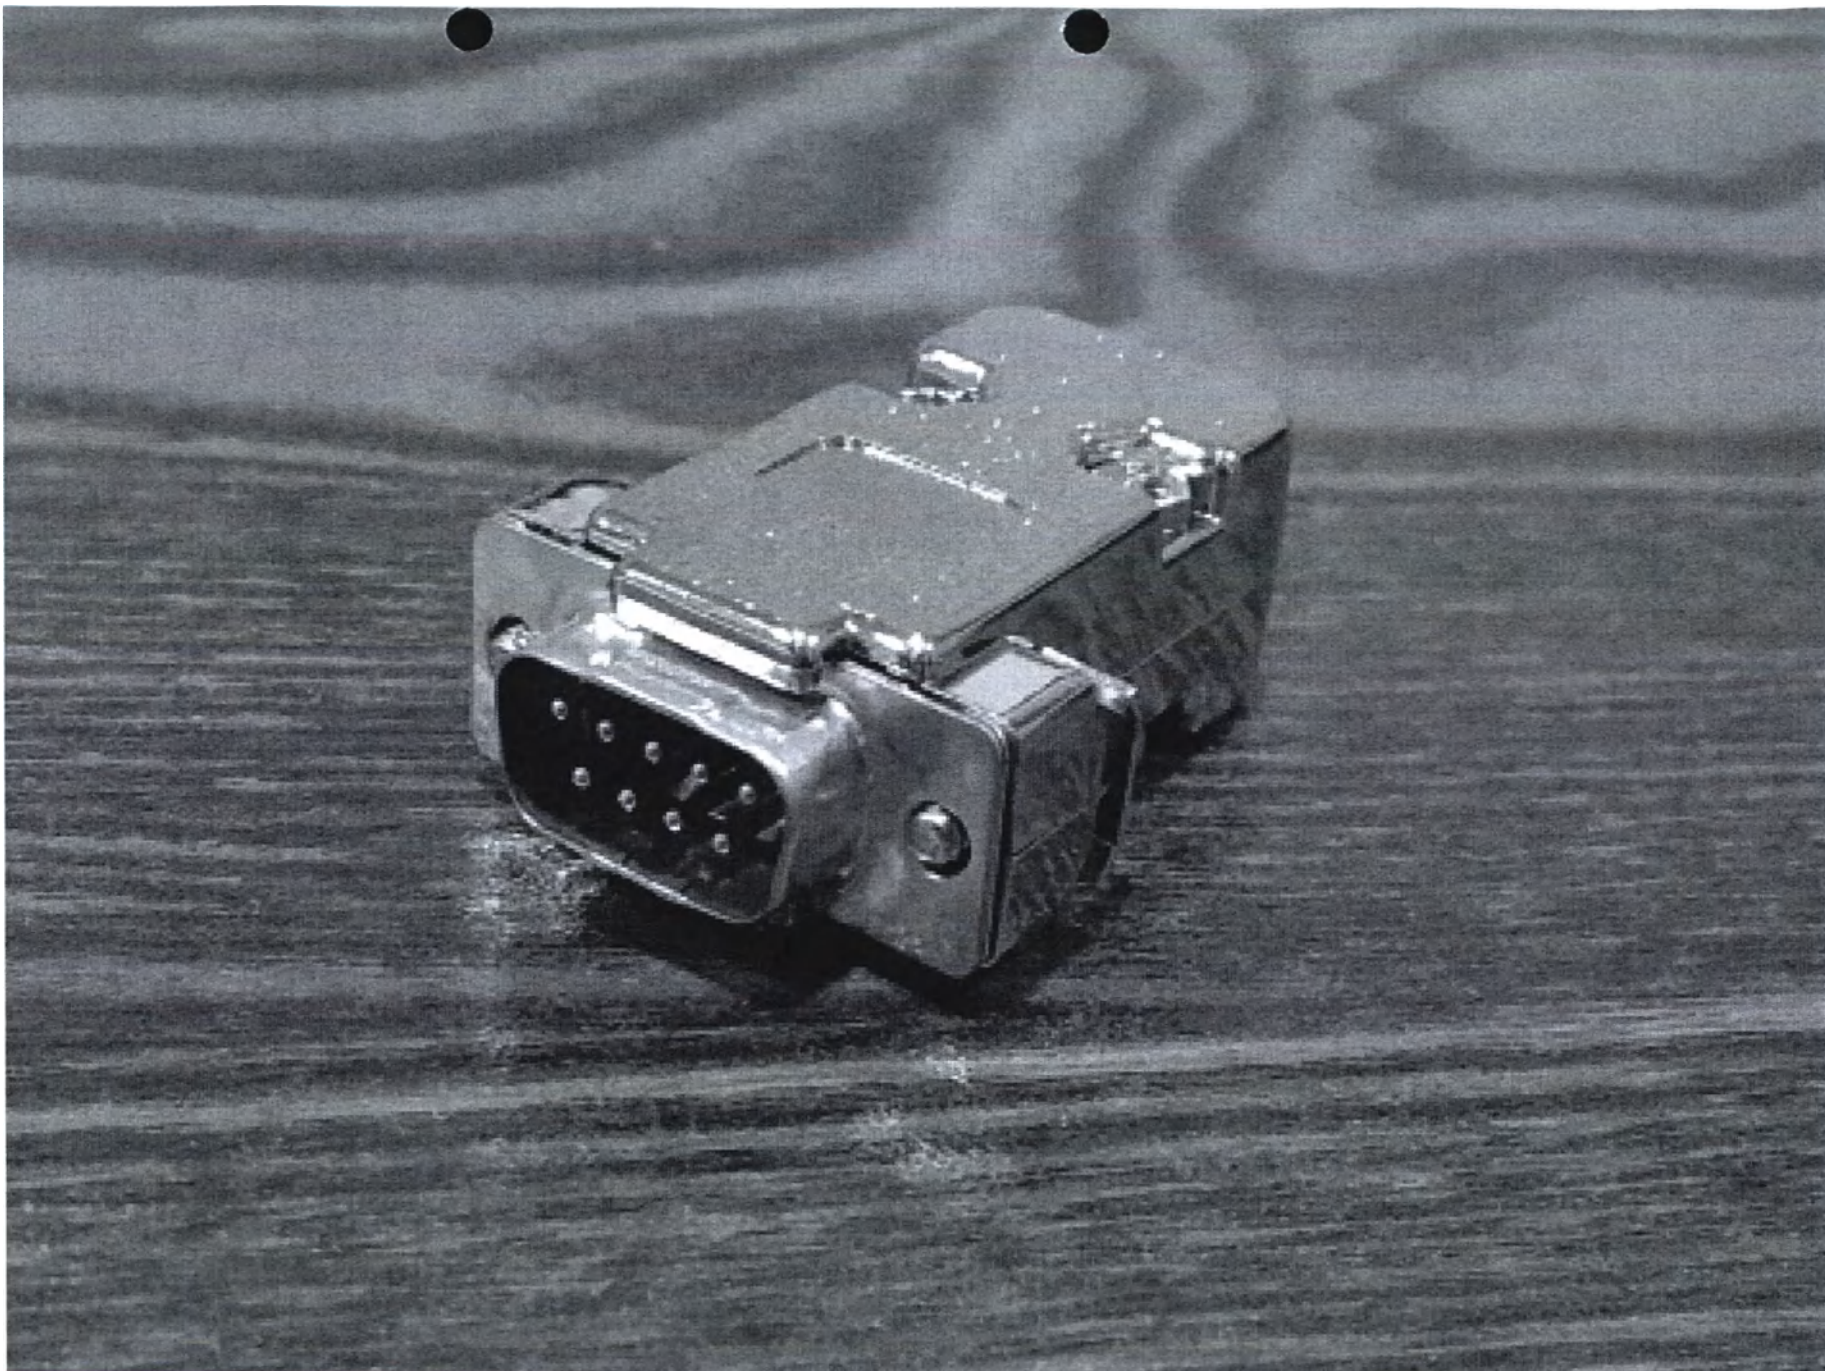


28. Заглушка для соединительного разъема педали (Dummy plug)




29. Кабель питания (Power cord)

38


II. Микротом ротационный HistoCore MULTICUT (Rotary Microtome HistoCore MULTICUT), в составе:

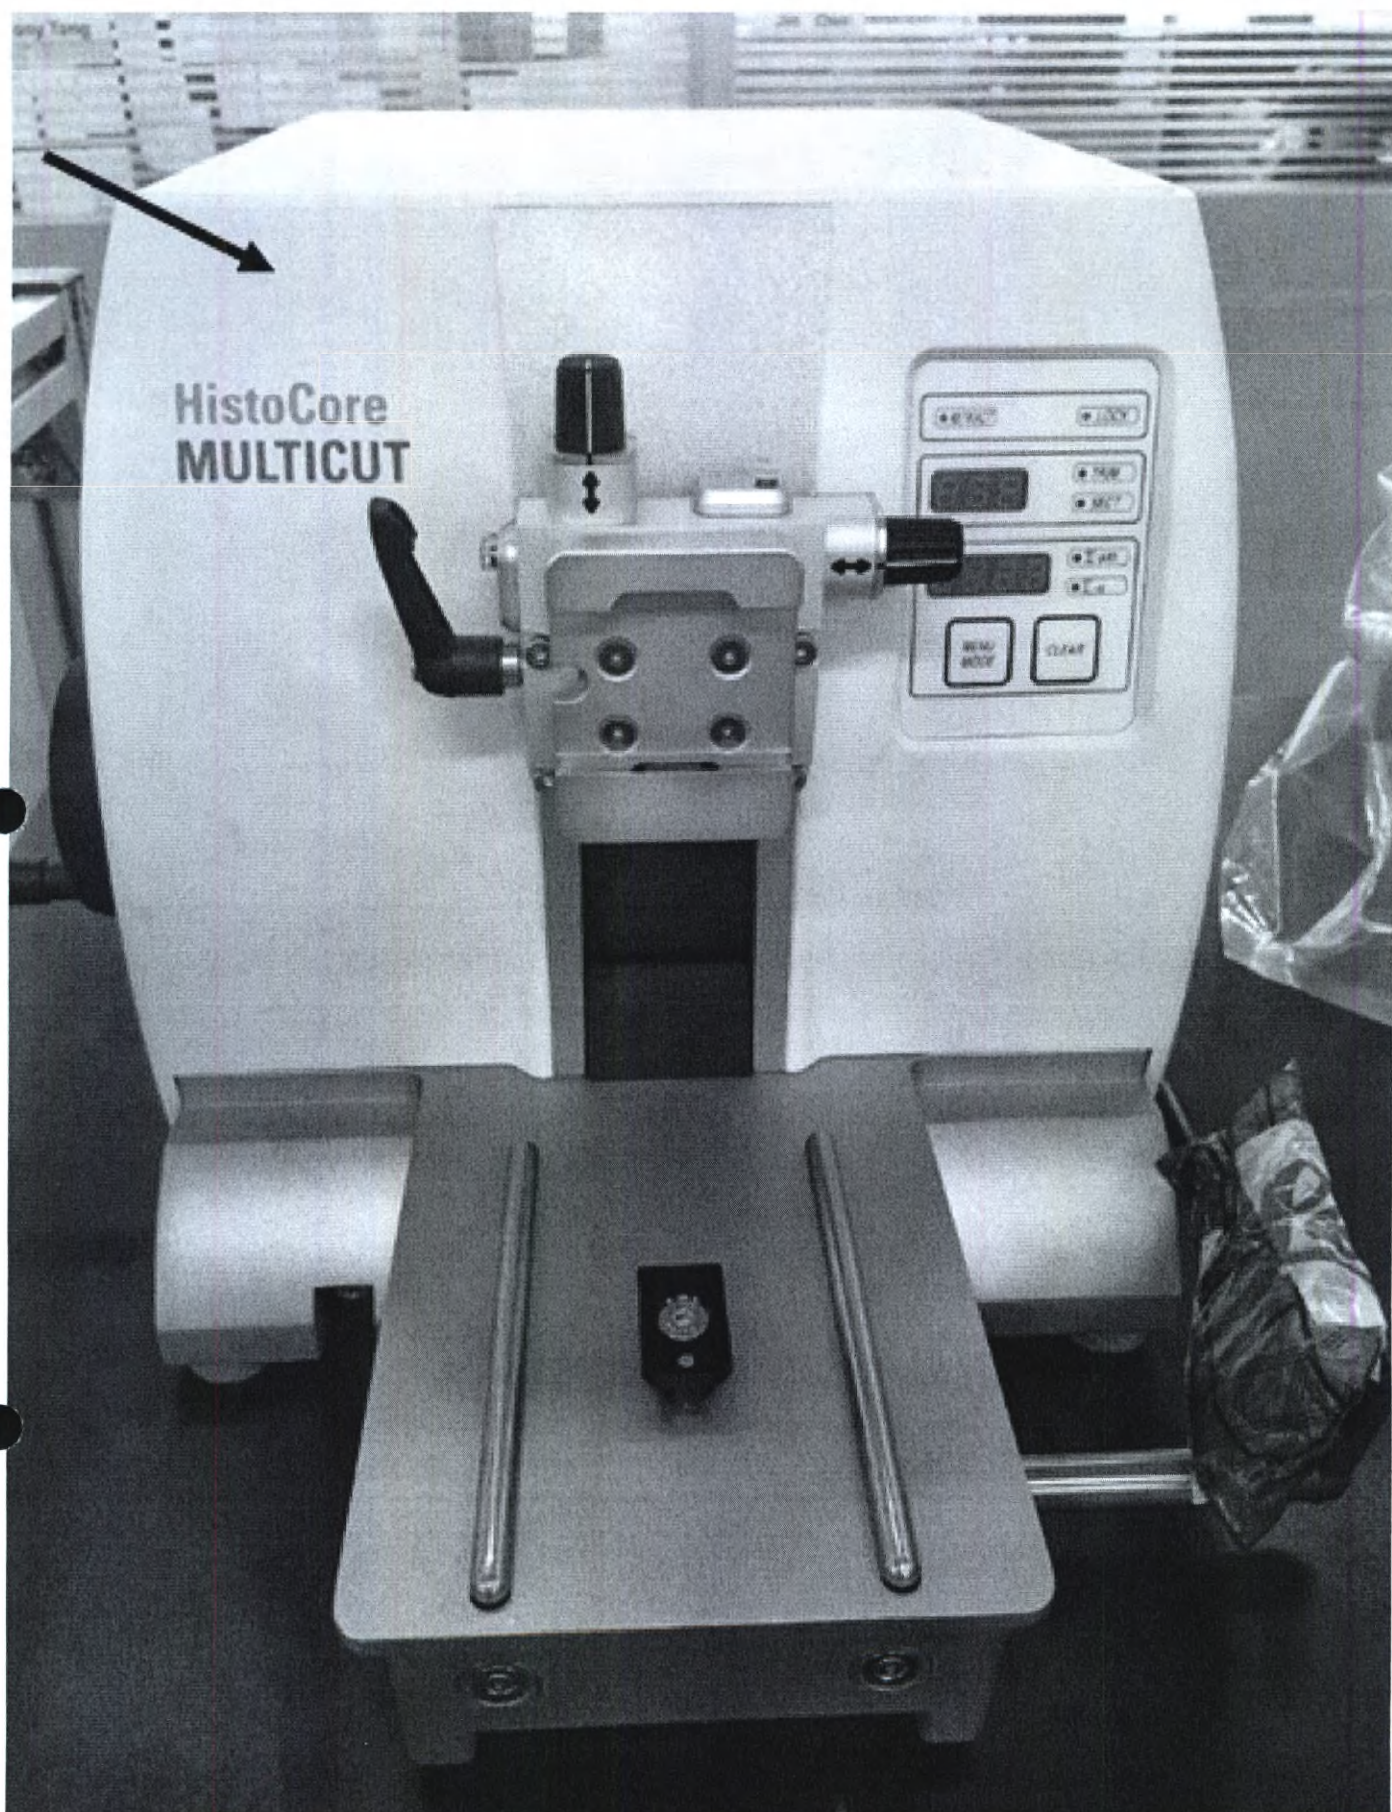

1. Прибор базовый HistoCore MULTICUT (Basic instrument HistoCore MULTICUT)

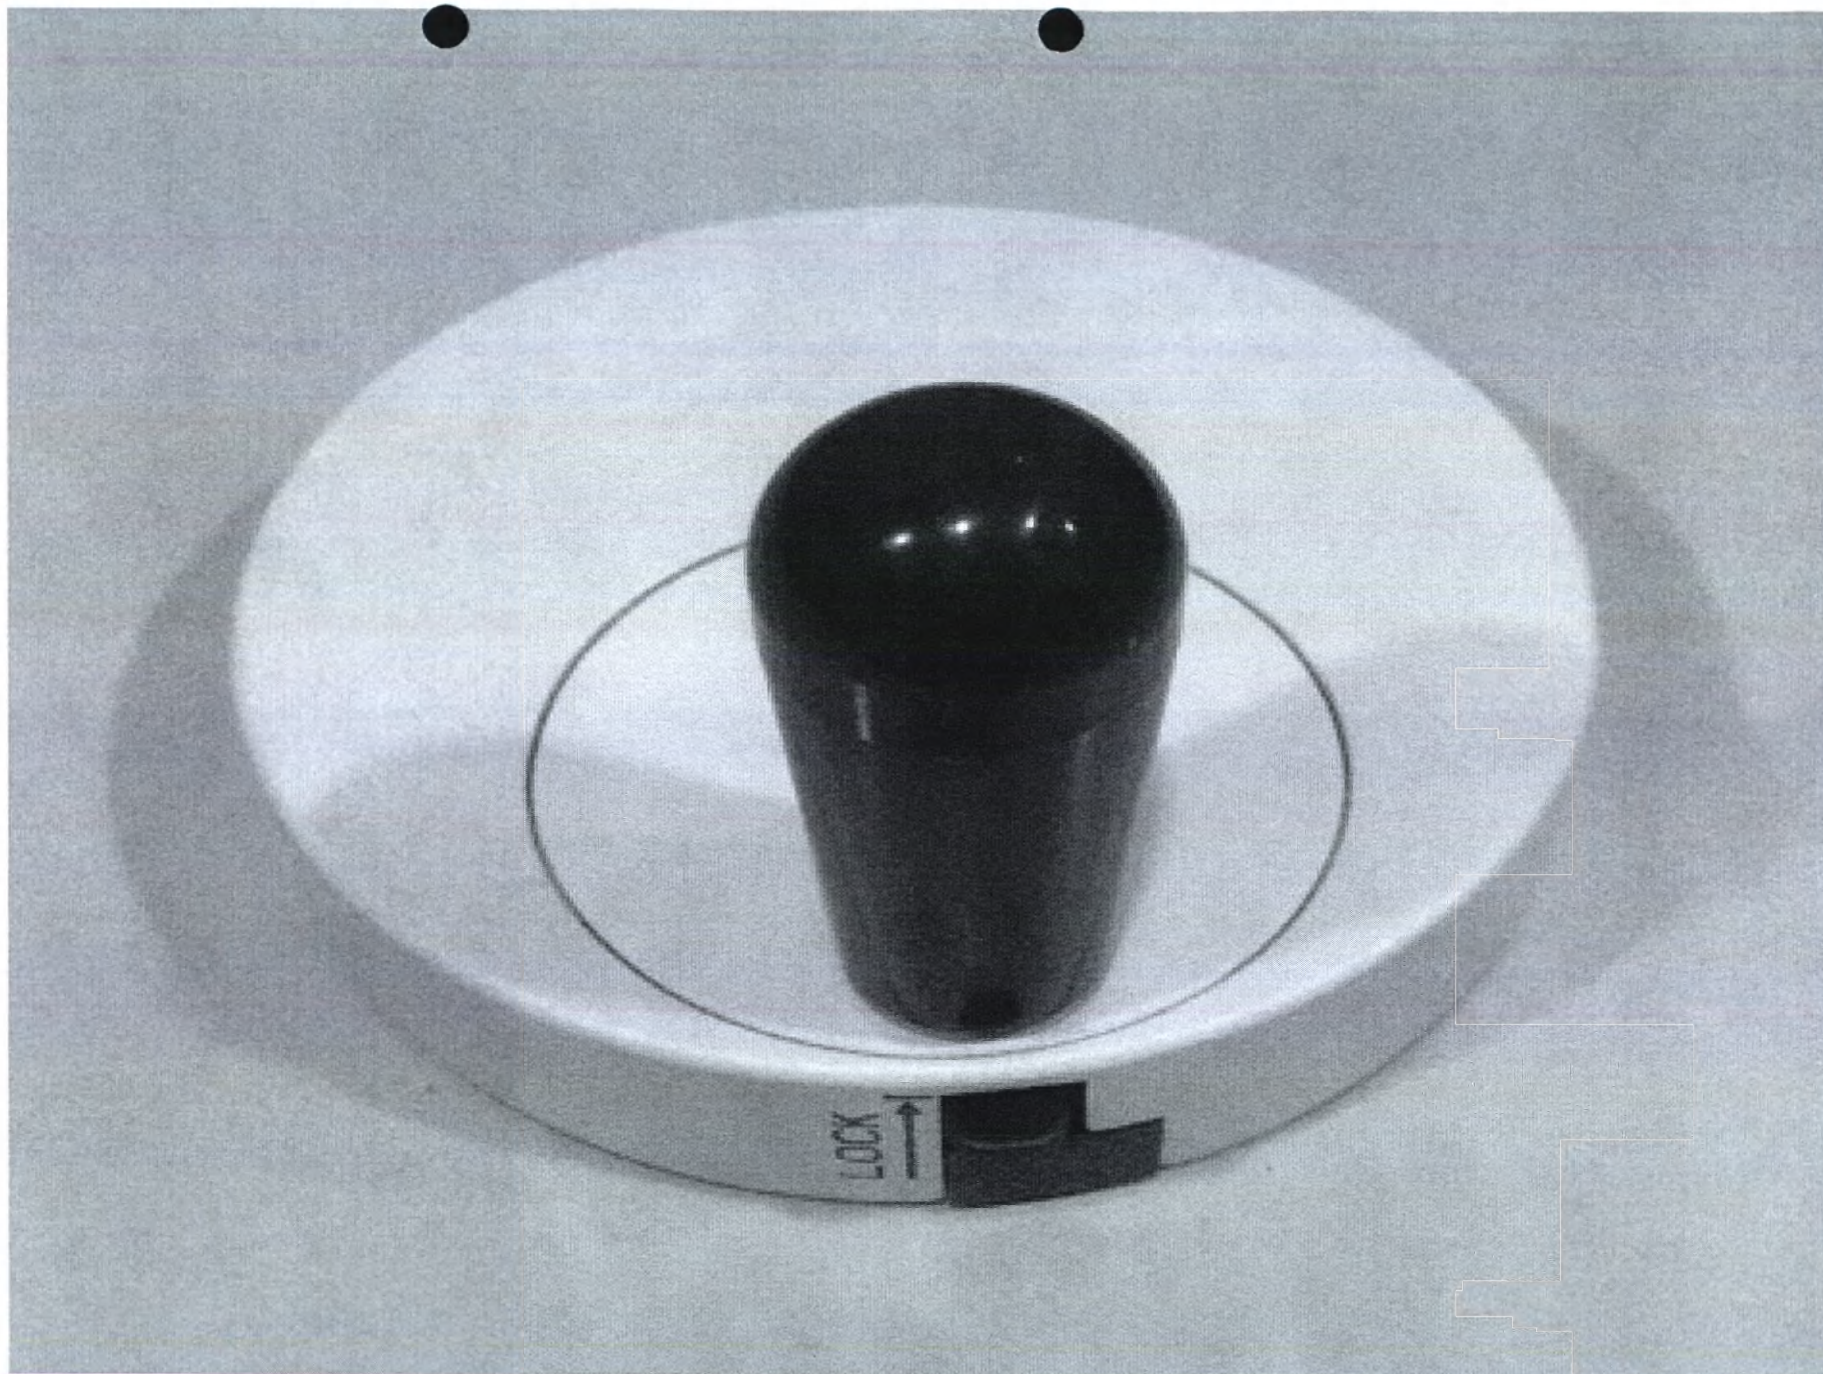


2. Маховик, в сборе (Handwheel, assembly)

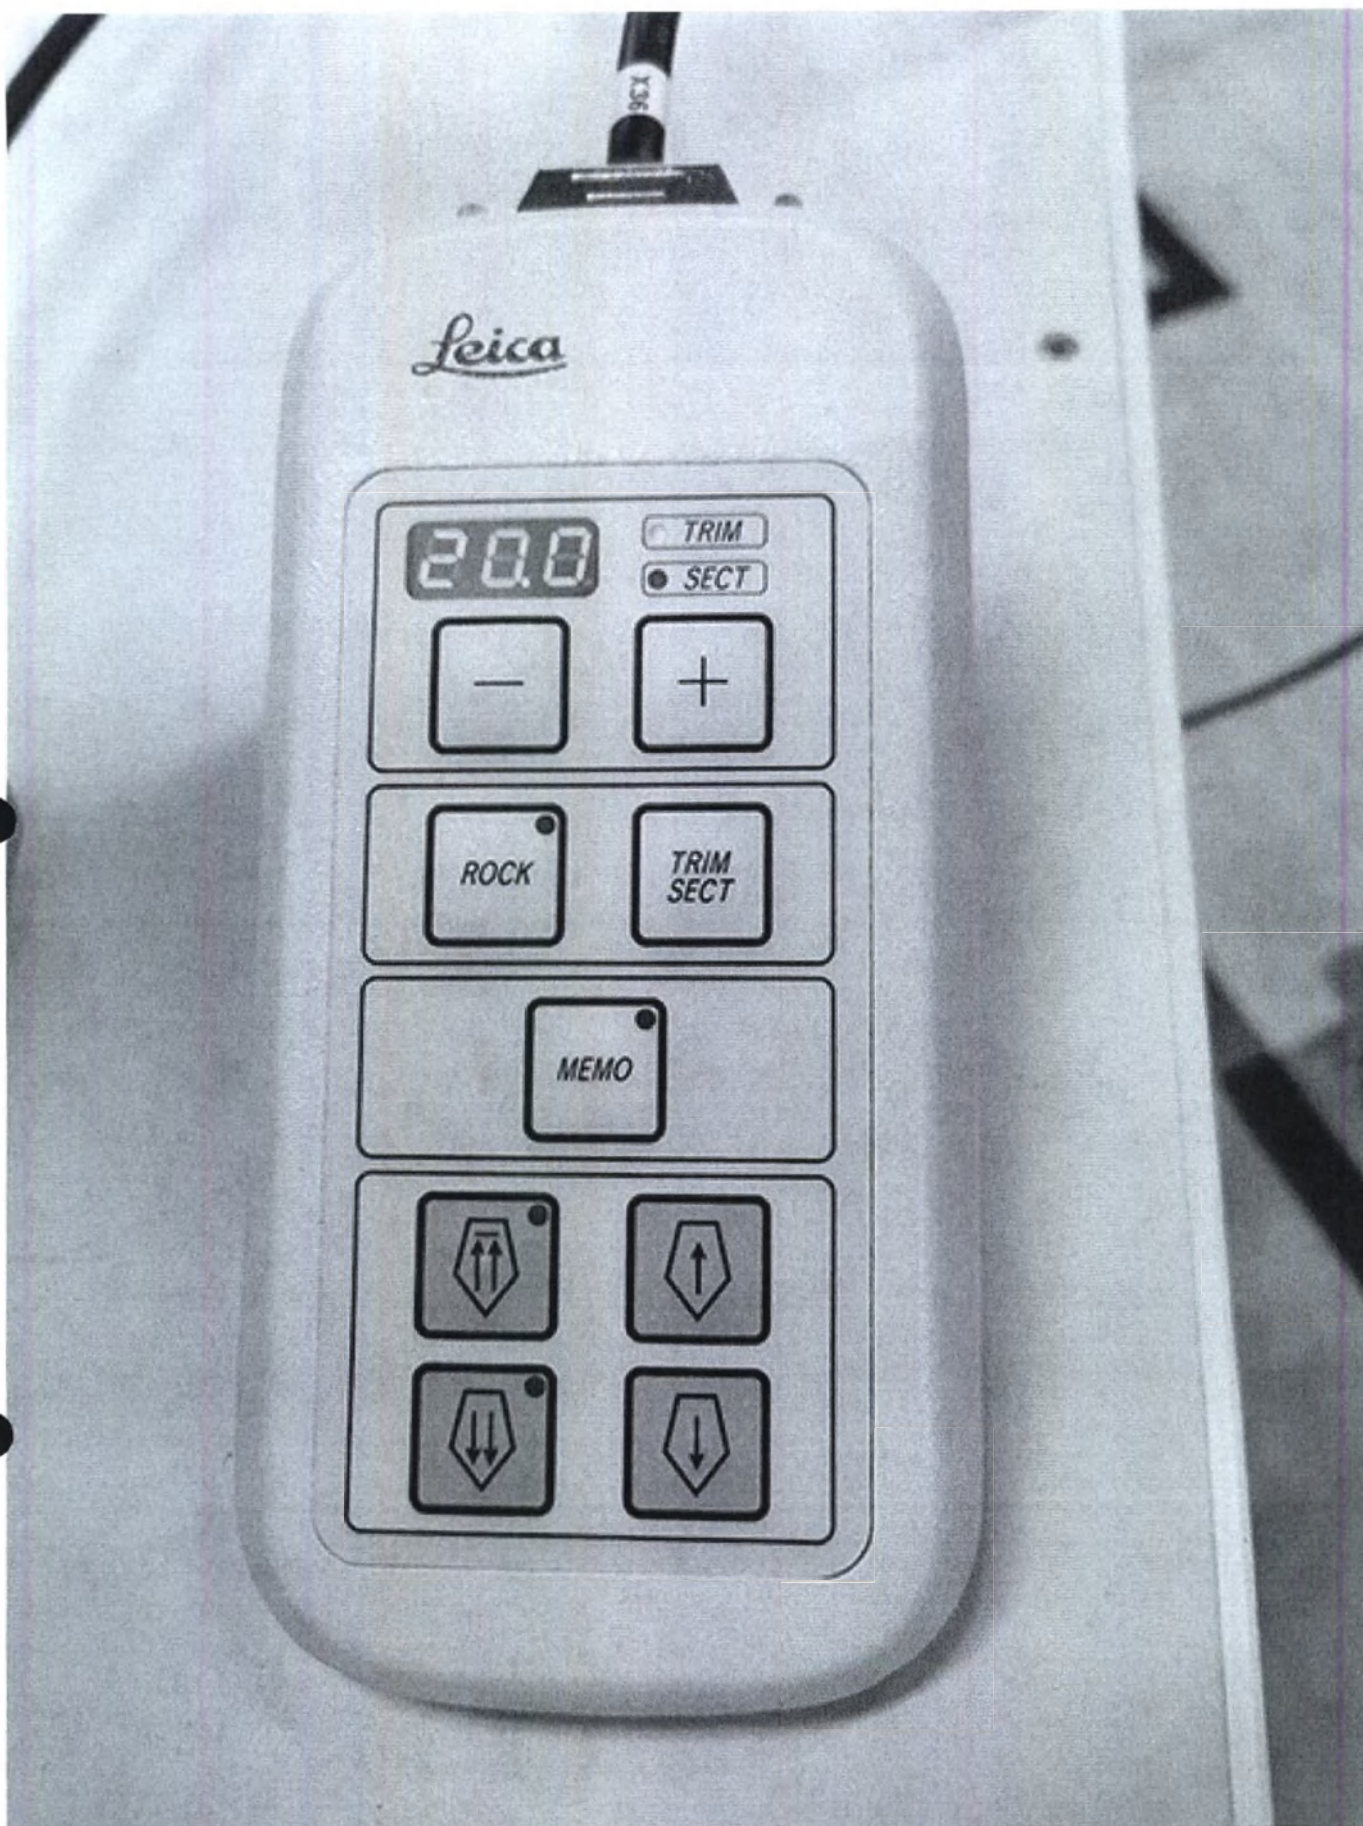

3. Панель управления отдельная, HistoCore MULTICUT (Separate control panel, HistoCore MULTICUT)



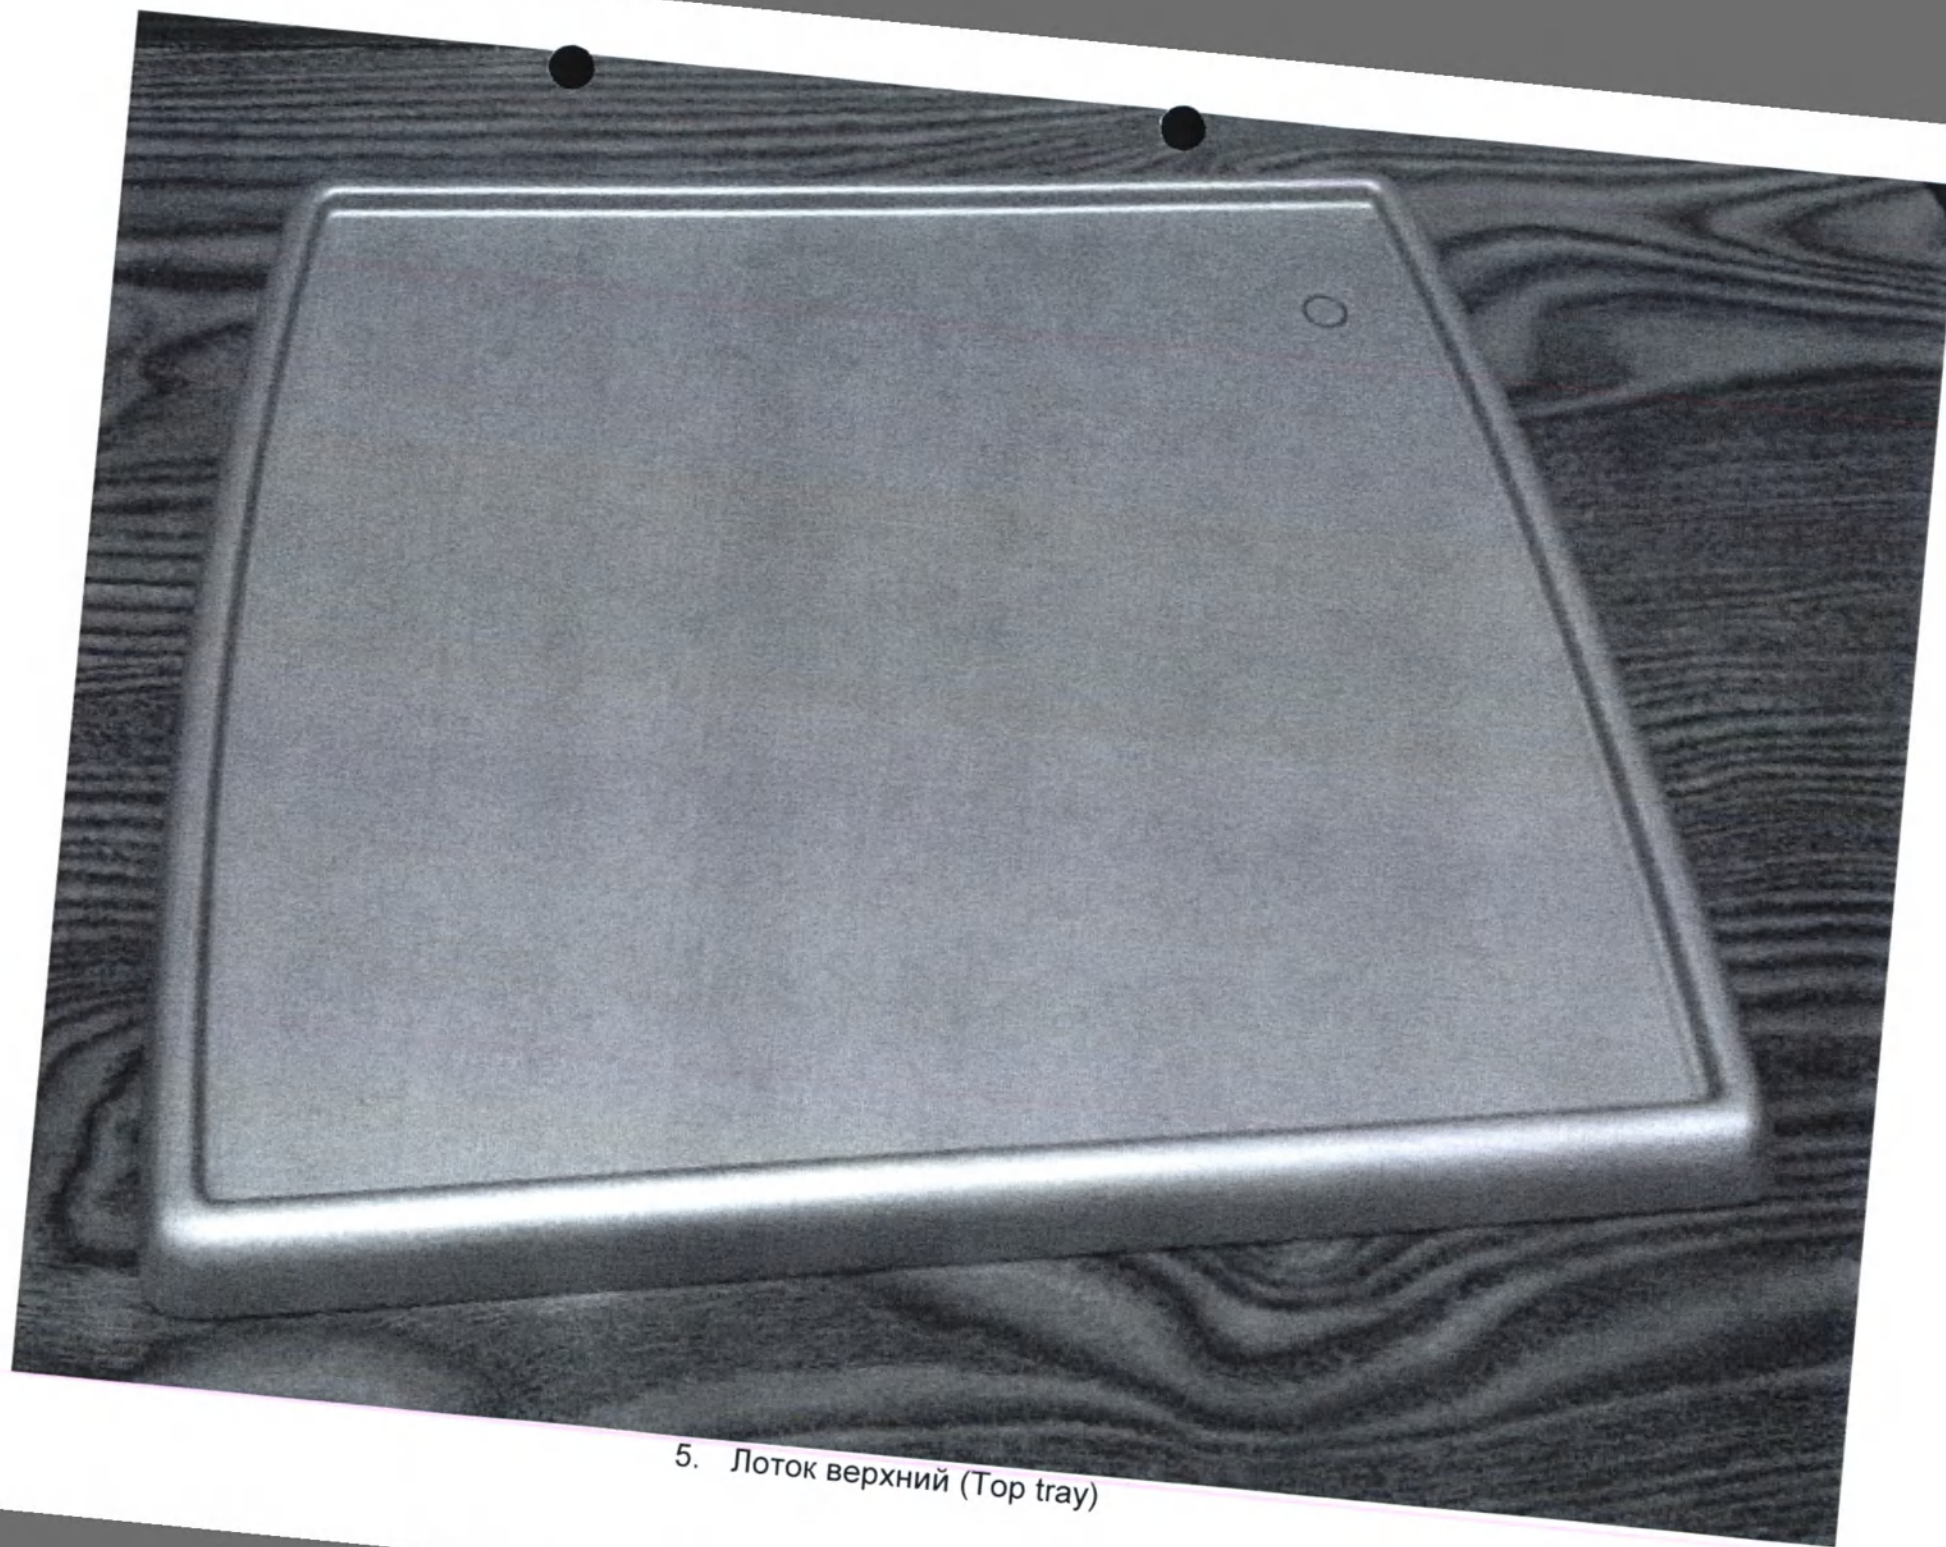

5. Лоток верхний (Top tray)



6. Набор сервисный (Service pack), в составе:



6.1. Ключ Аллена №5 с рукояткой (Allen key №5 with handle)




6.2. Отвертка 3мм × 50мм (Screwdriver 3mm × 50mm)



6.3. Ключ Аллена №3 (Allen key №3)



6.5. Ключ Аллена №4 (Allen key №4)

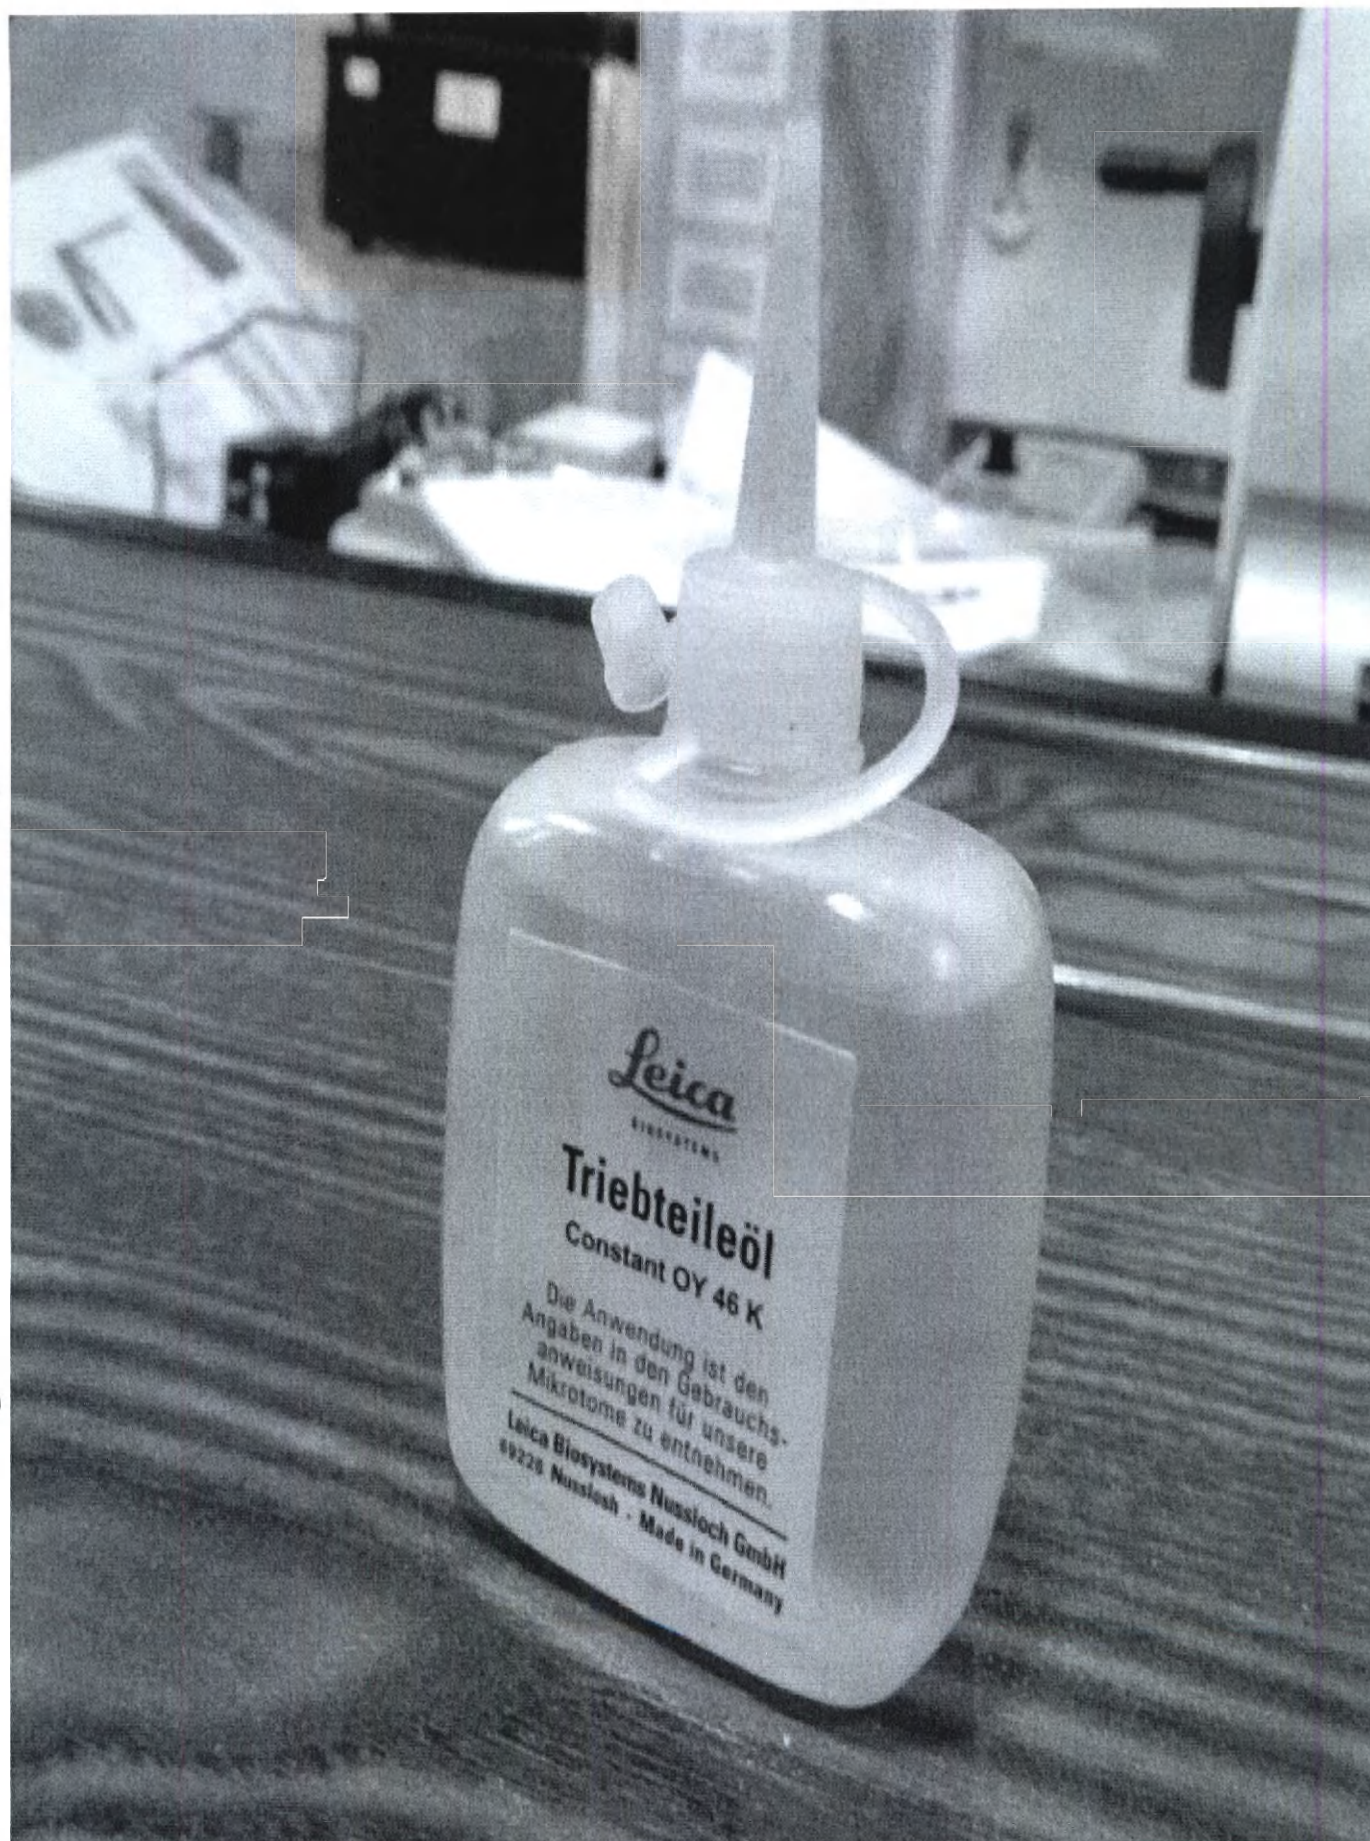

6.6. Масло машинное, 50мл (Oil for drives, 50 ml)




6.7. Кисть с магнитом (Brush with magnet)




6.8. Колпак пылезащитный (Dust cover)




7. Предохранитель плавкий Т1,0АL, 250В (Fuse Lead T1,0AL, 250V)

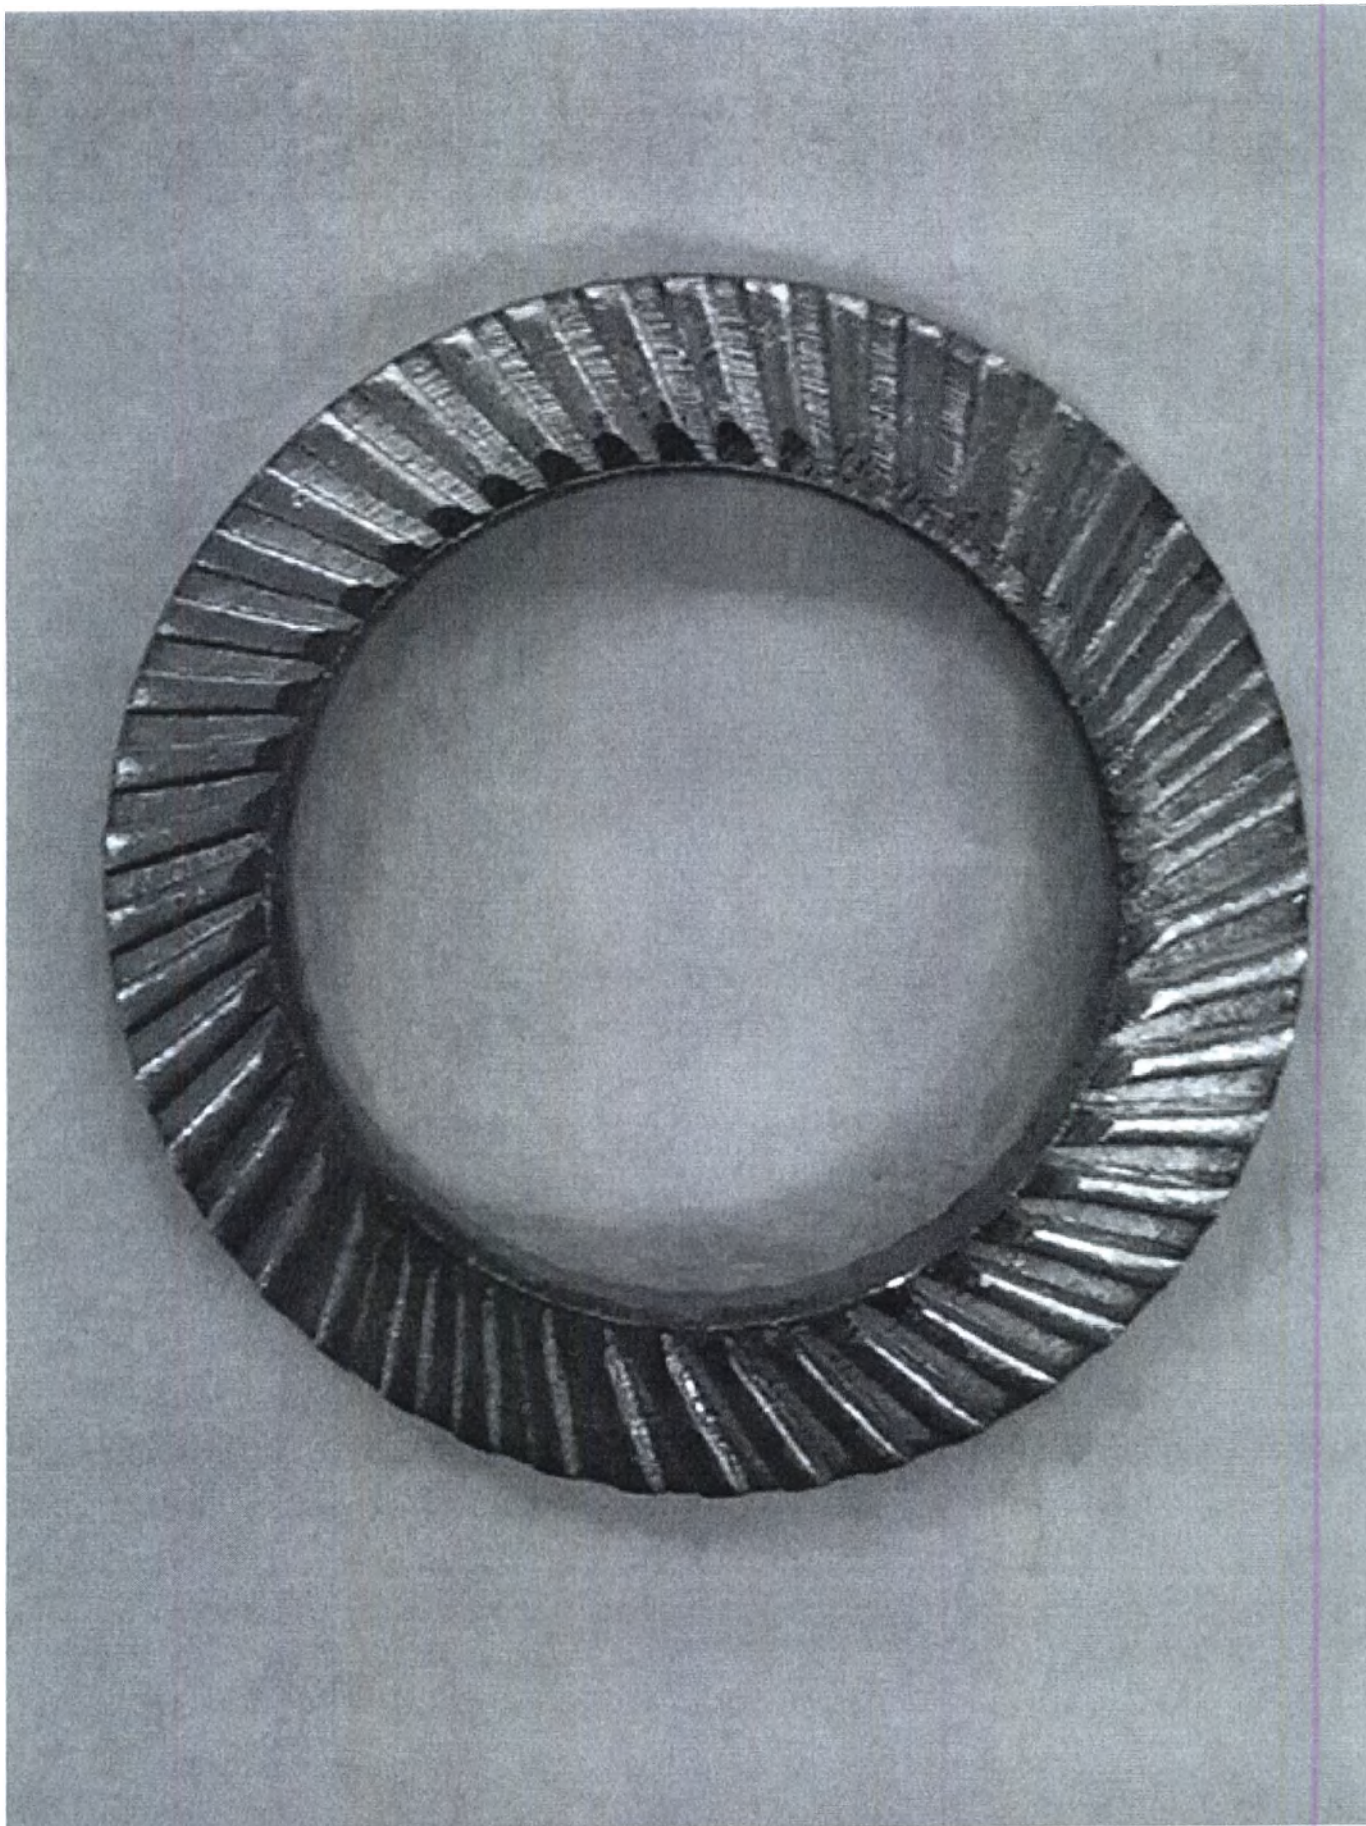


8. Шайба предохранительная Schnorr 10×6,4×0,7 (Schnorr-Safety Washer 10×6,4×0,7)

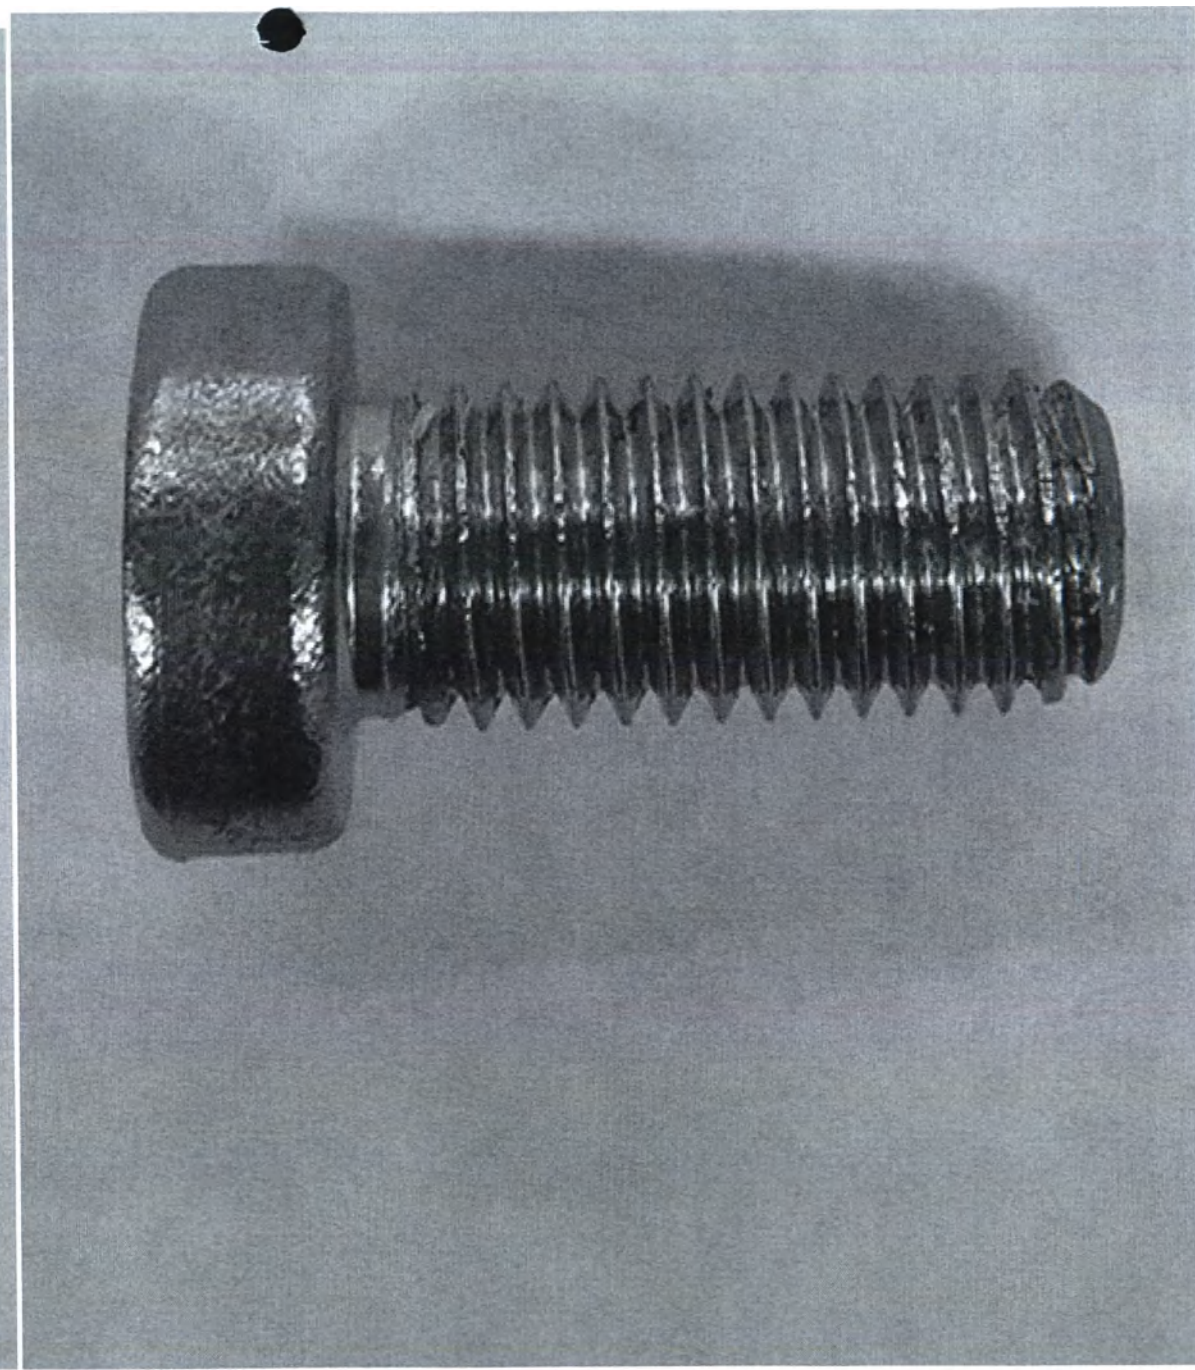

9. Винт с внутренним шестигранником M6×16 DIN7984 (Allen screw M6x16 DIN7984)

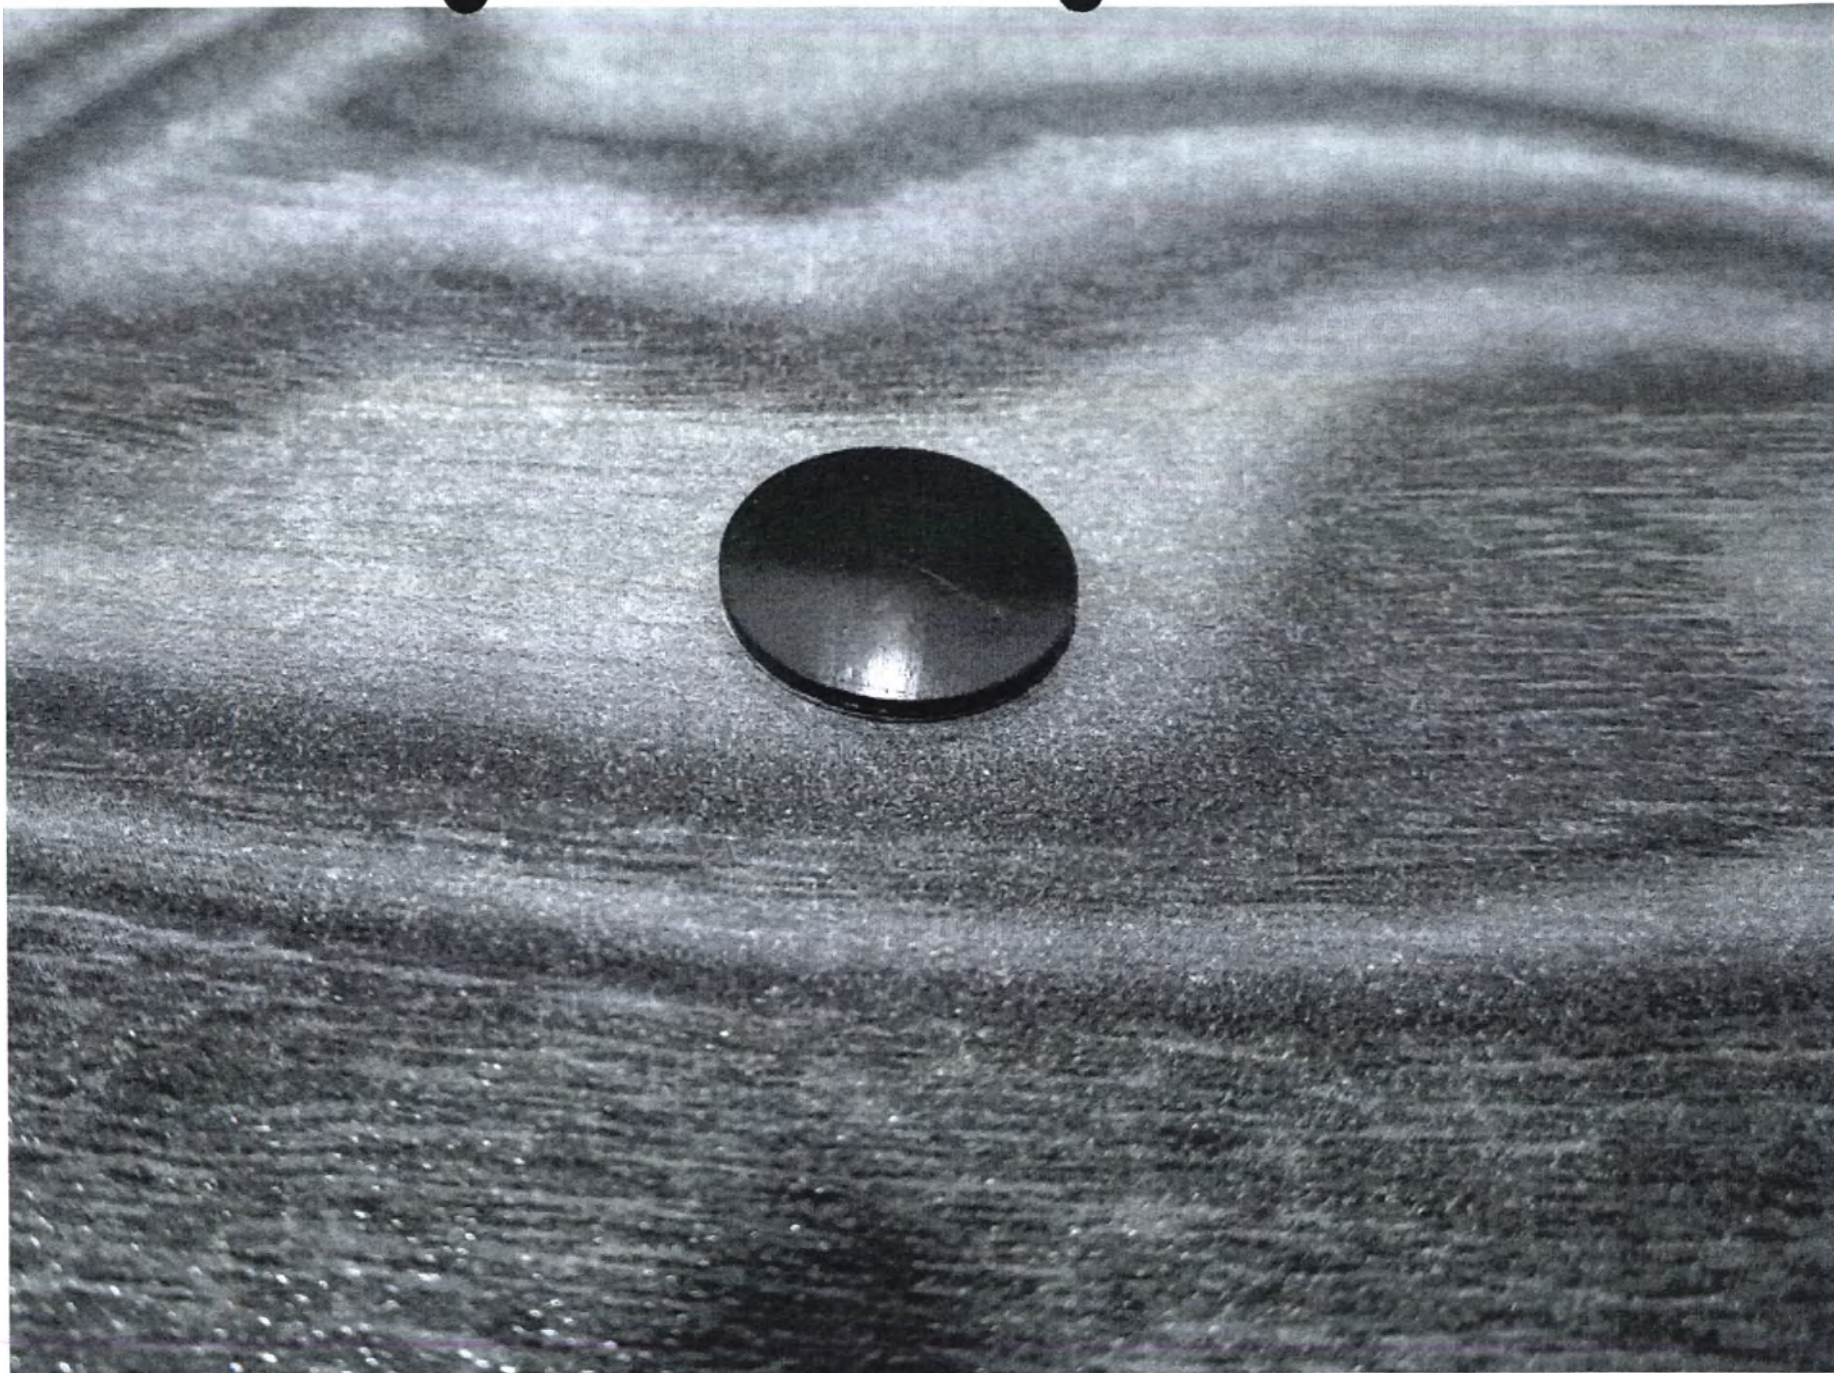


10. Крышка (Cover Disc)

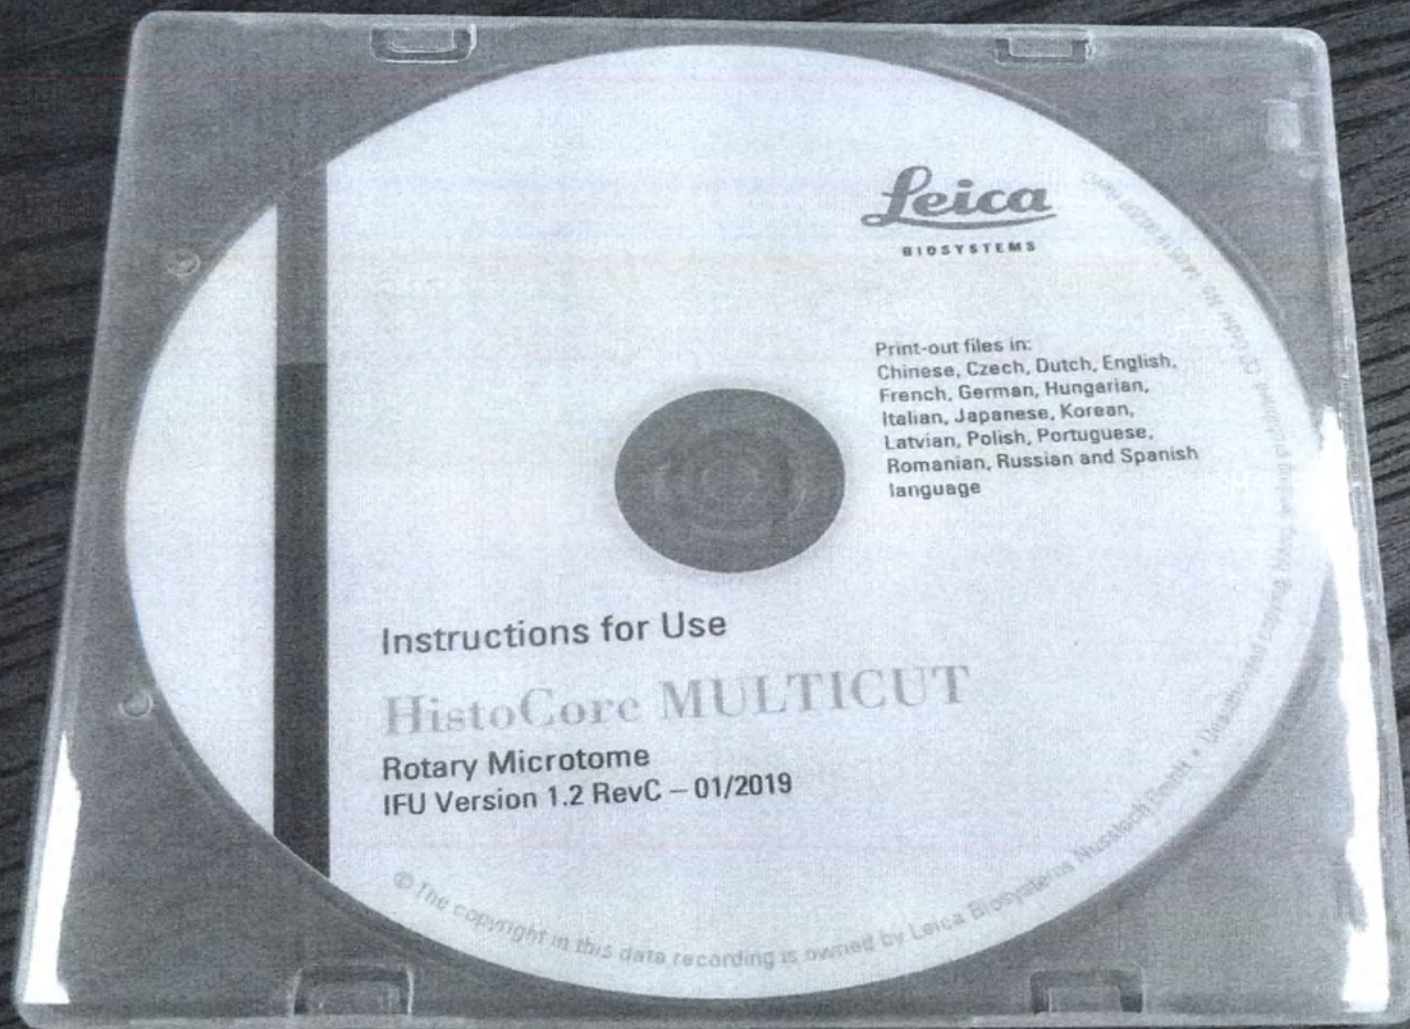


- руководство по эксплуатации на CD диске




- руководство по эксплуатации на CD диске

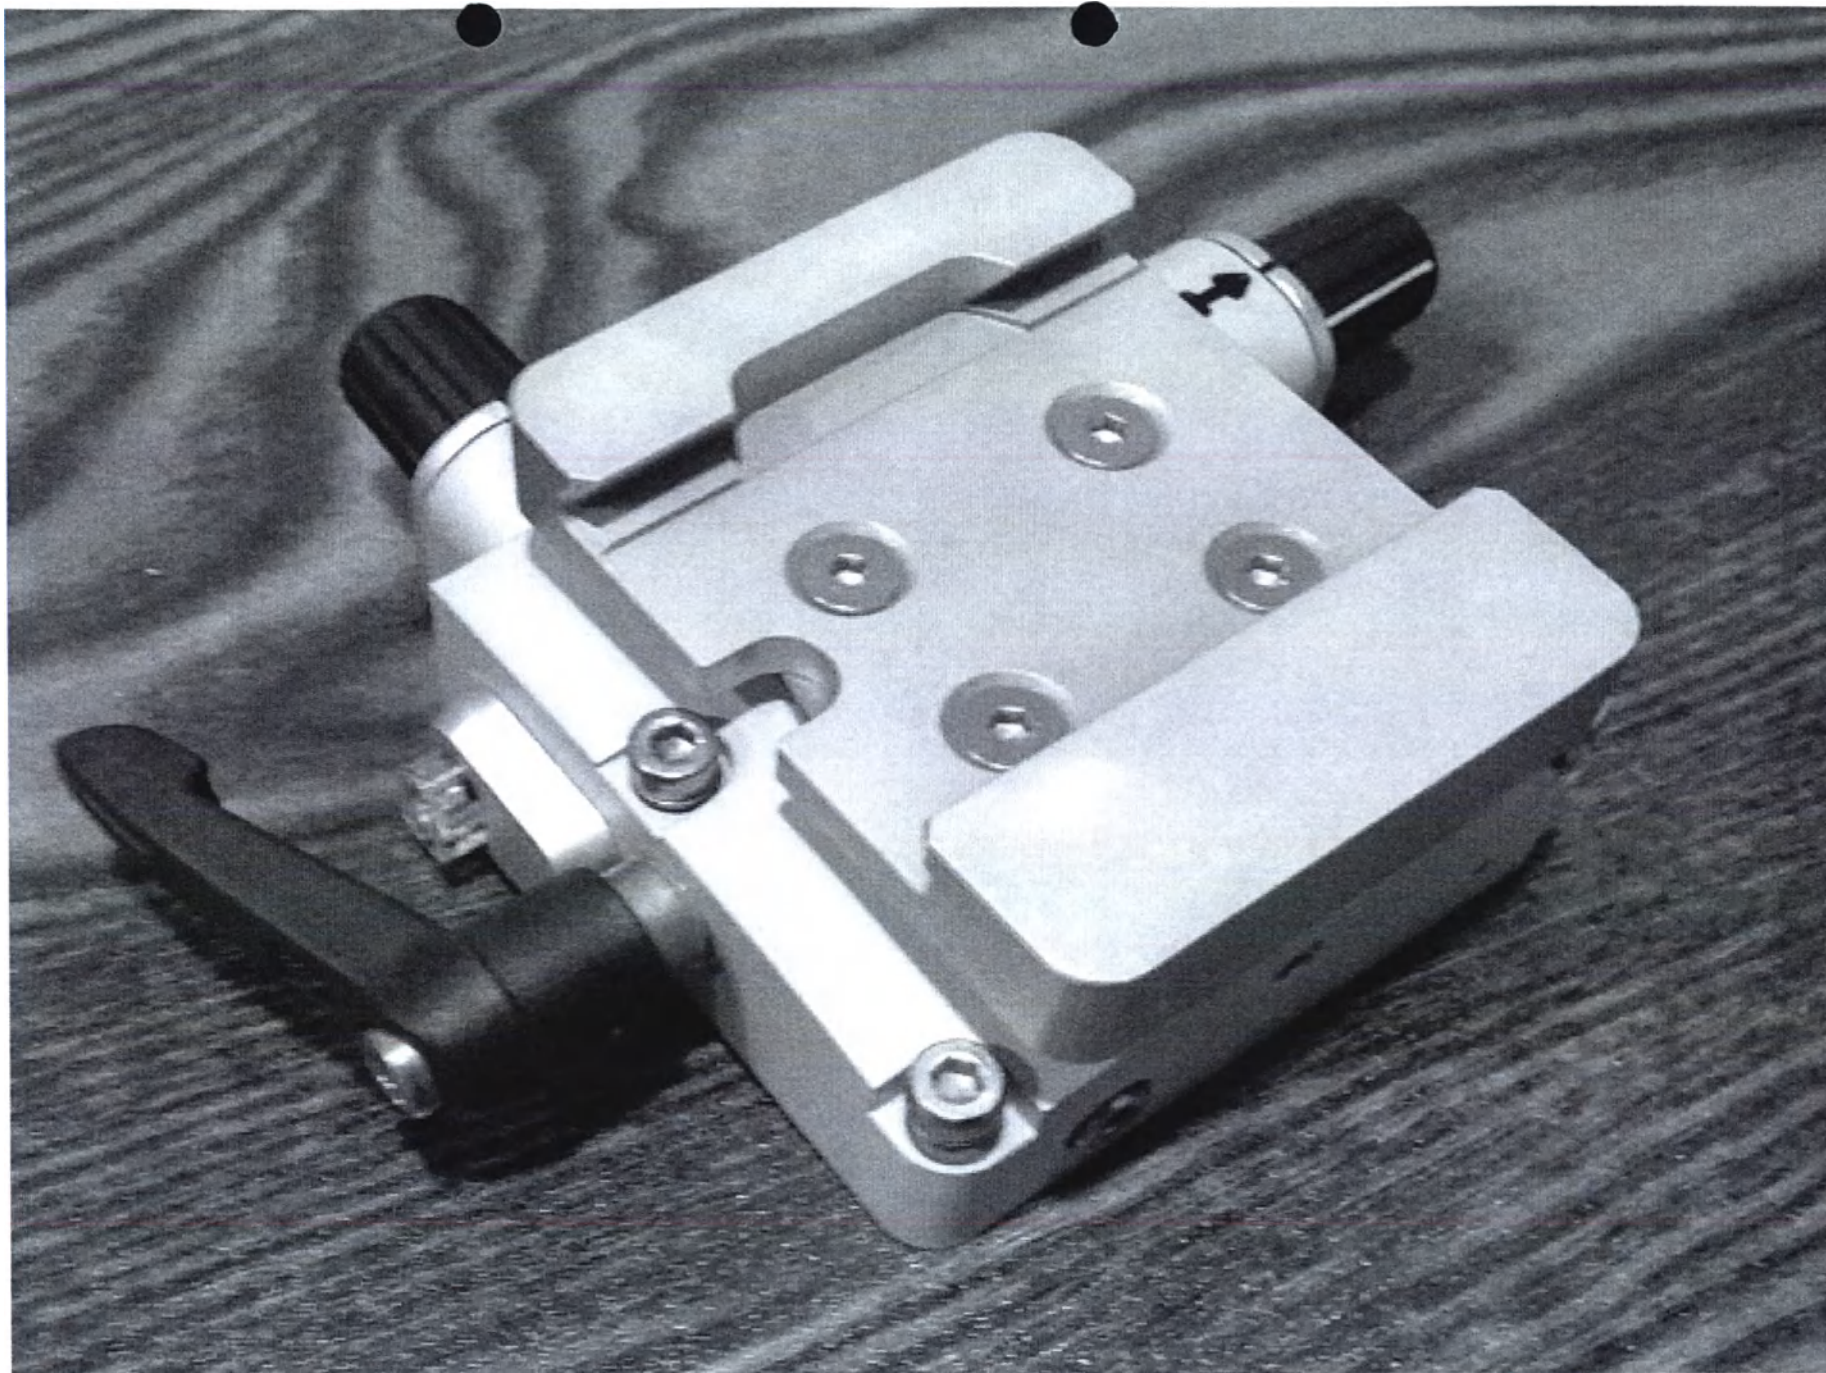


12. Крепление для быстрого зажима образца с точной ориентацией (Fine-directional fixture for specimen clamp)

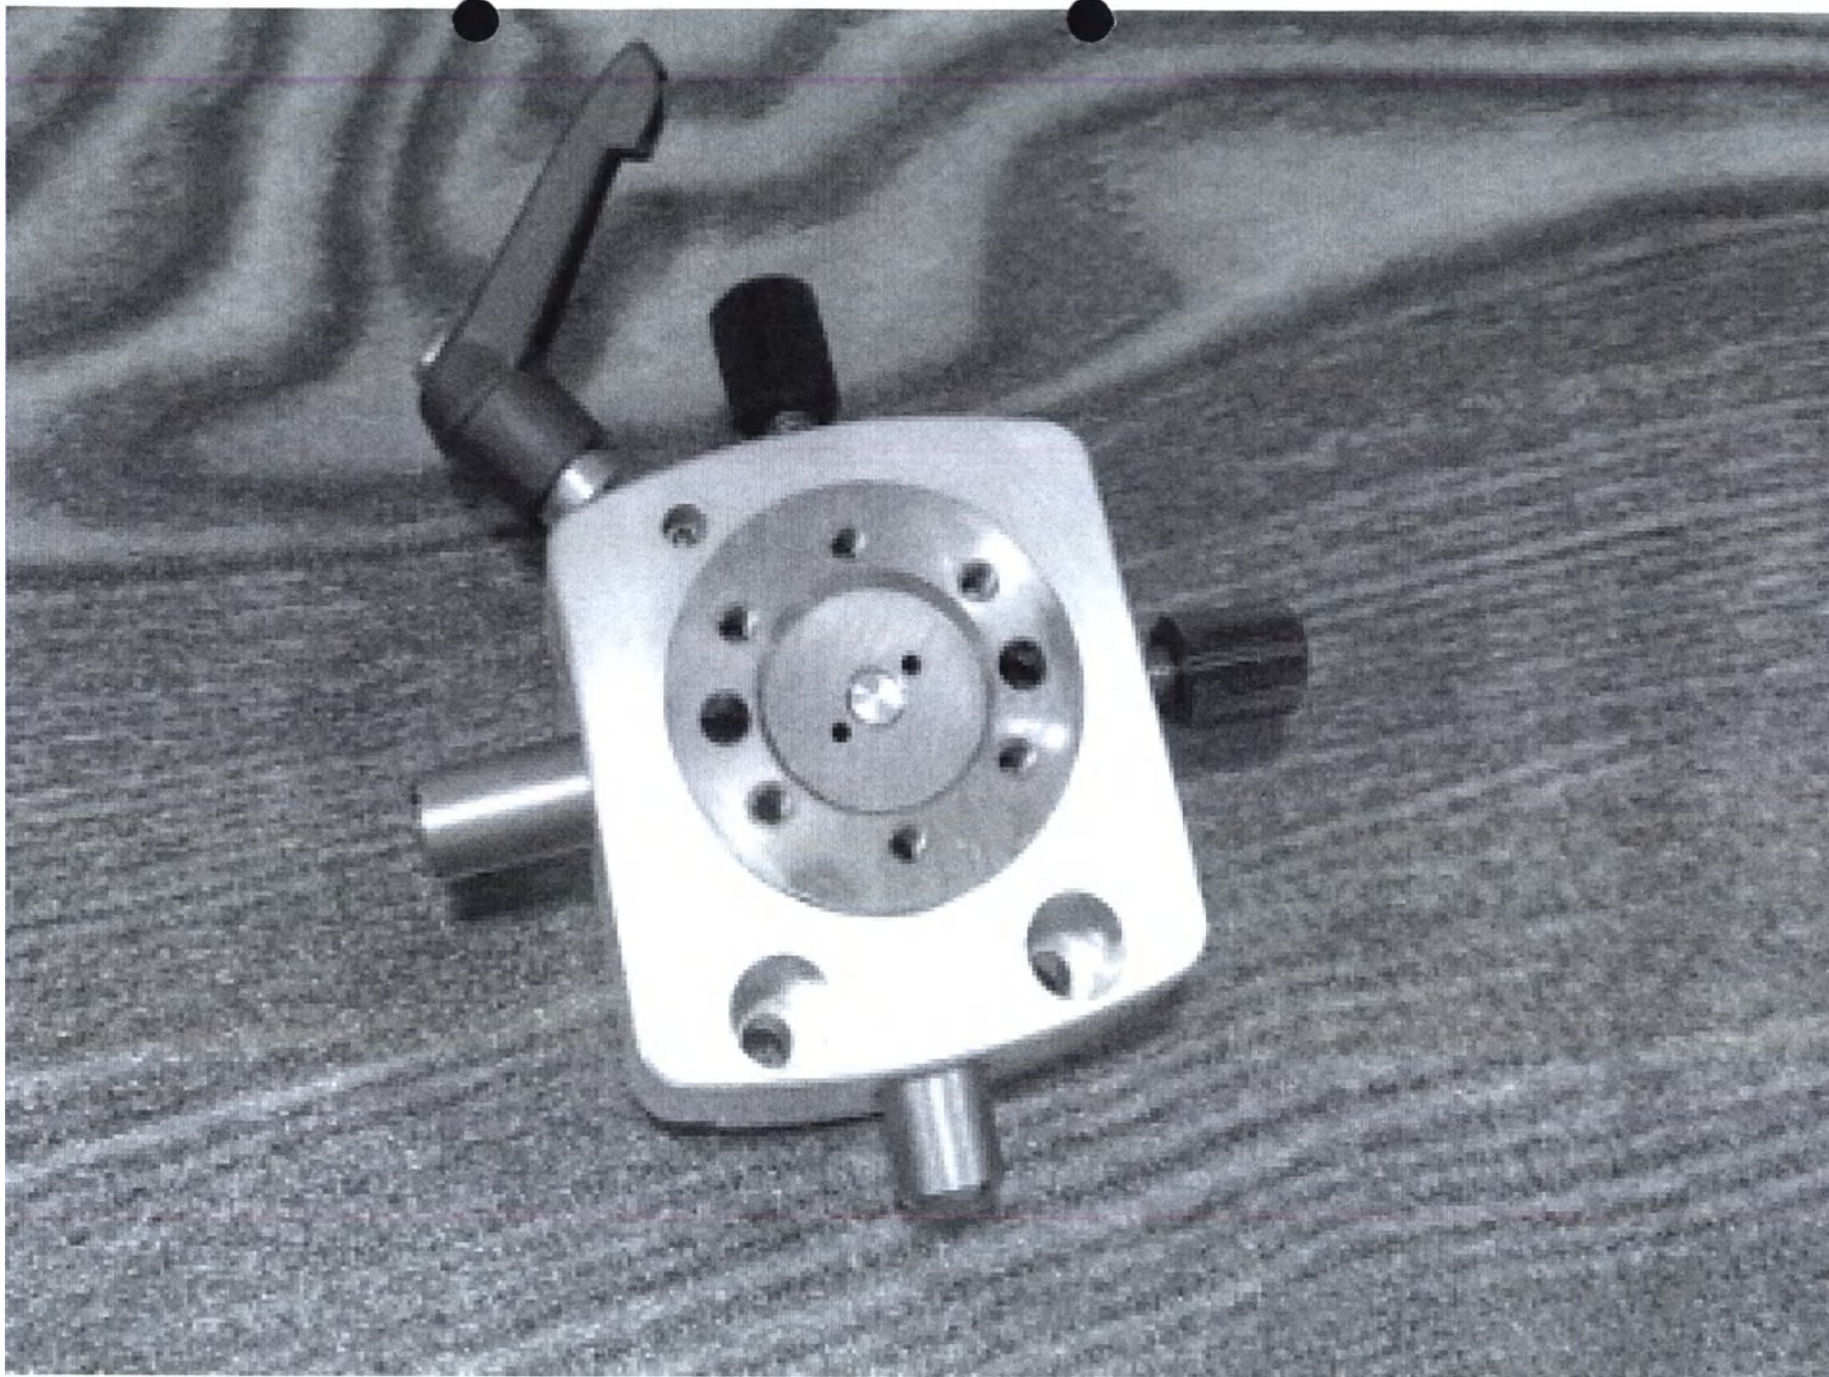


13. Крепление для быстрого зажима образца с простой ориентацией (Directional fixture for specimen clamp)

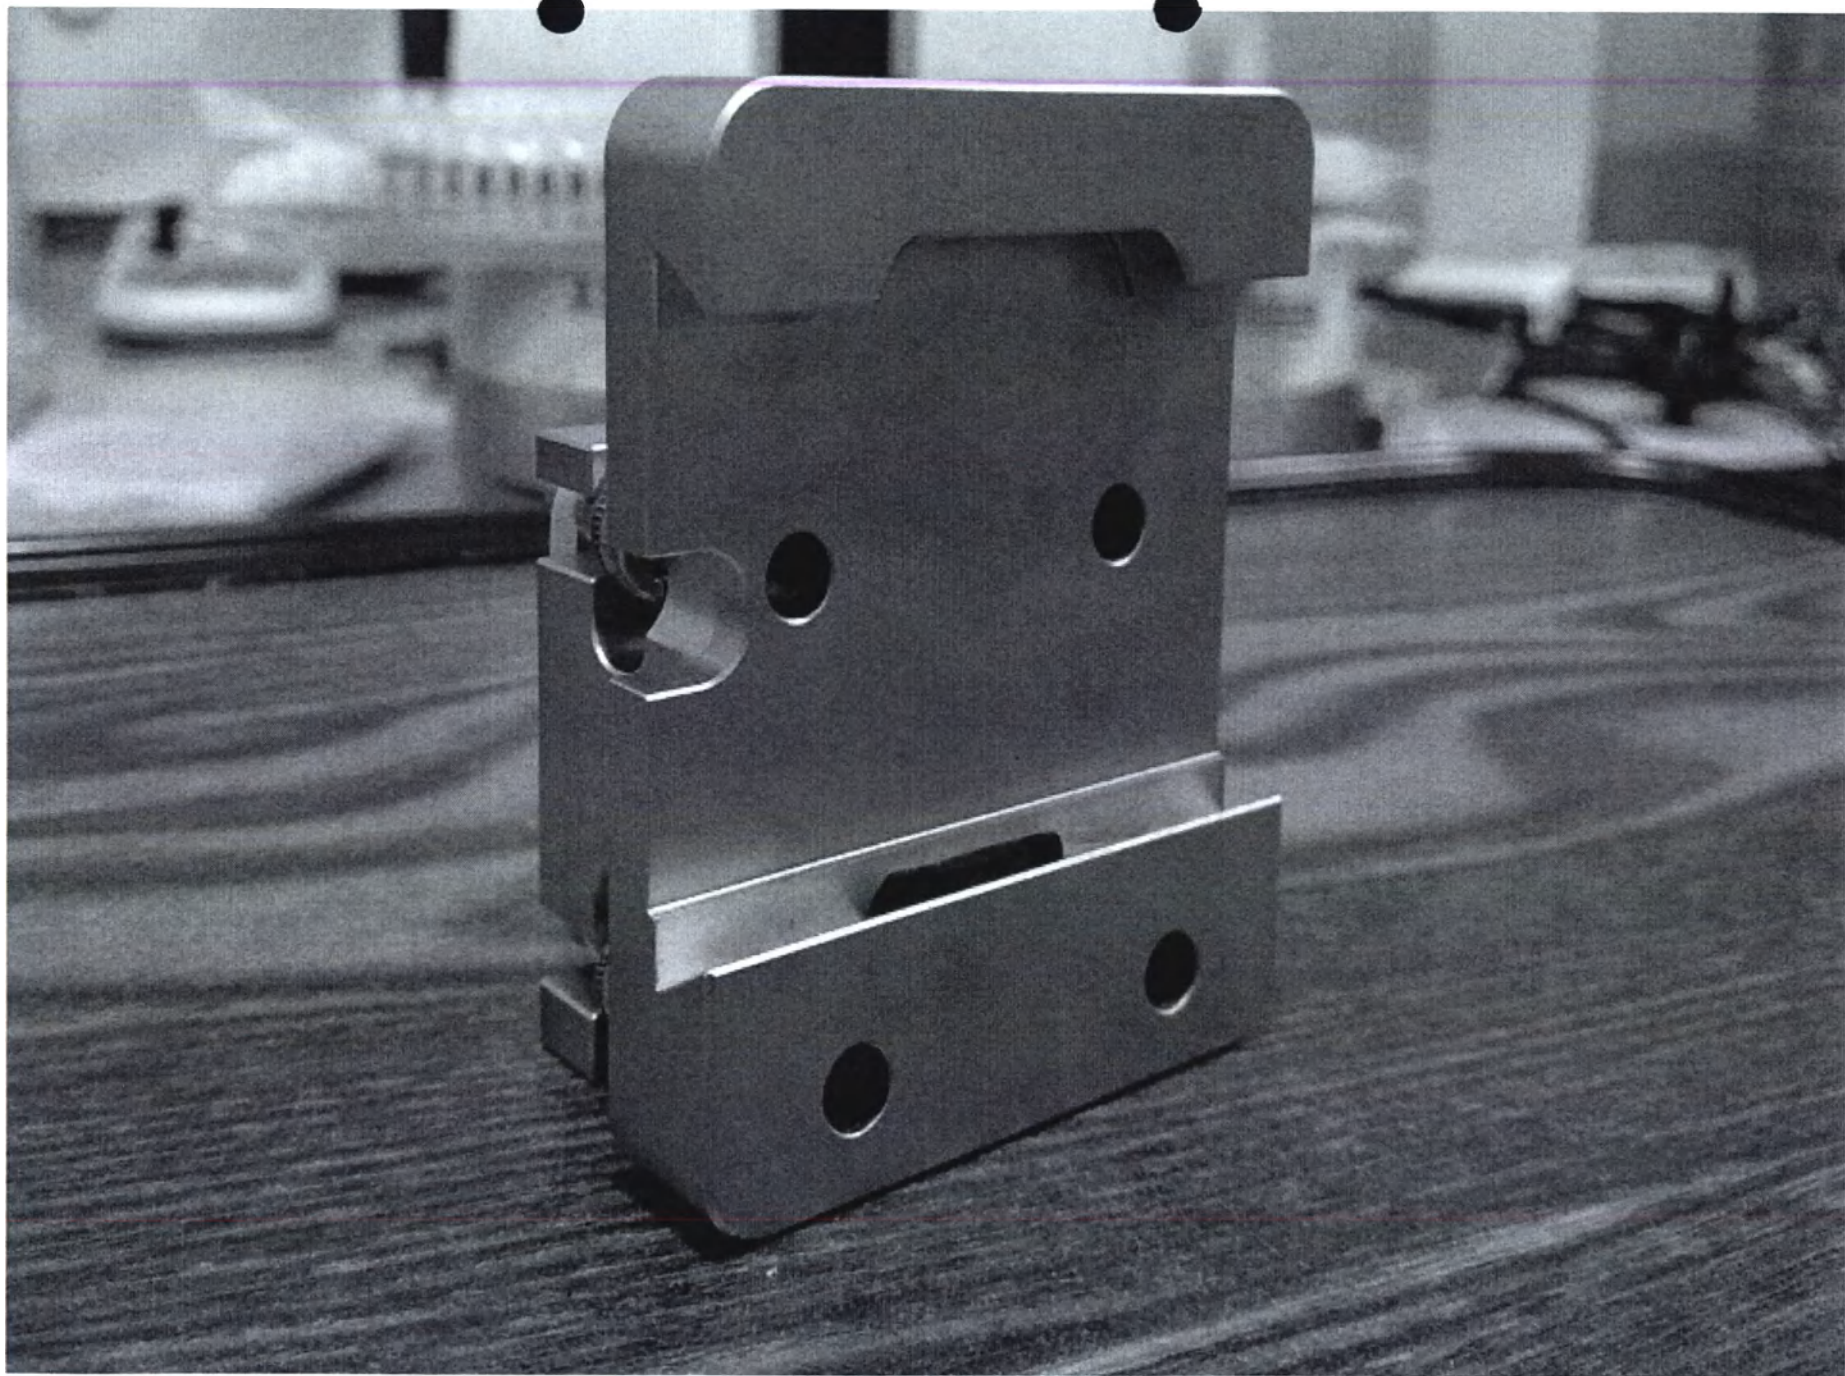

14. Жесткое крепление для зажима образца (Rigid fixture for specimen clamp)

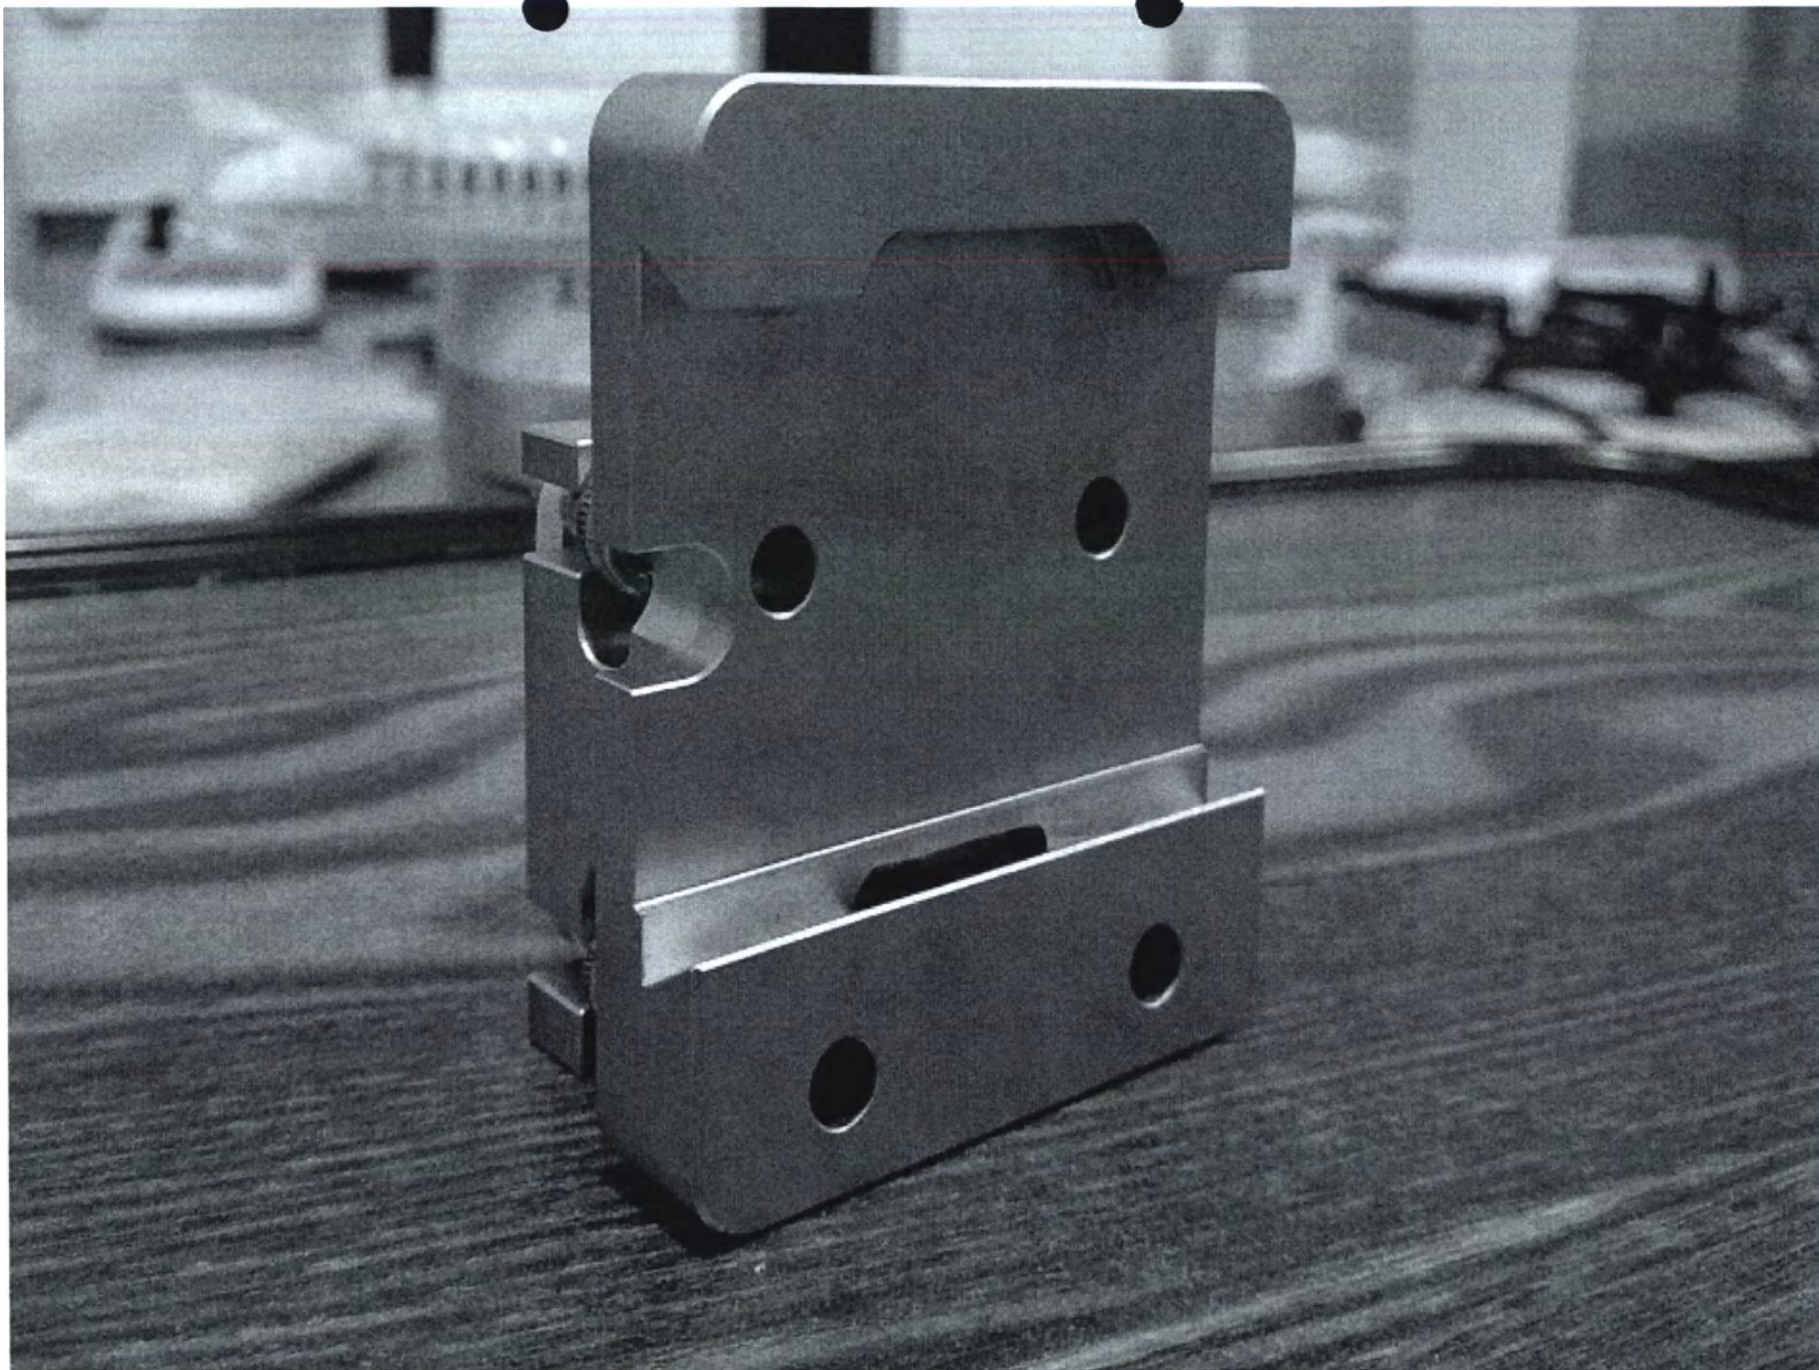


14. Жесткое крепление для зажима образца (Rigid fixture for specimen clamp)

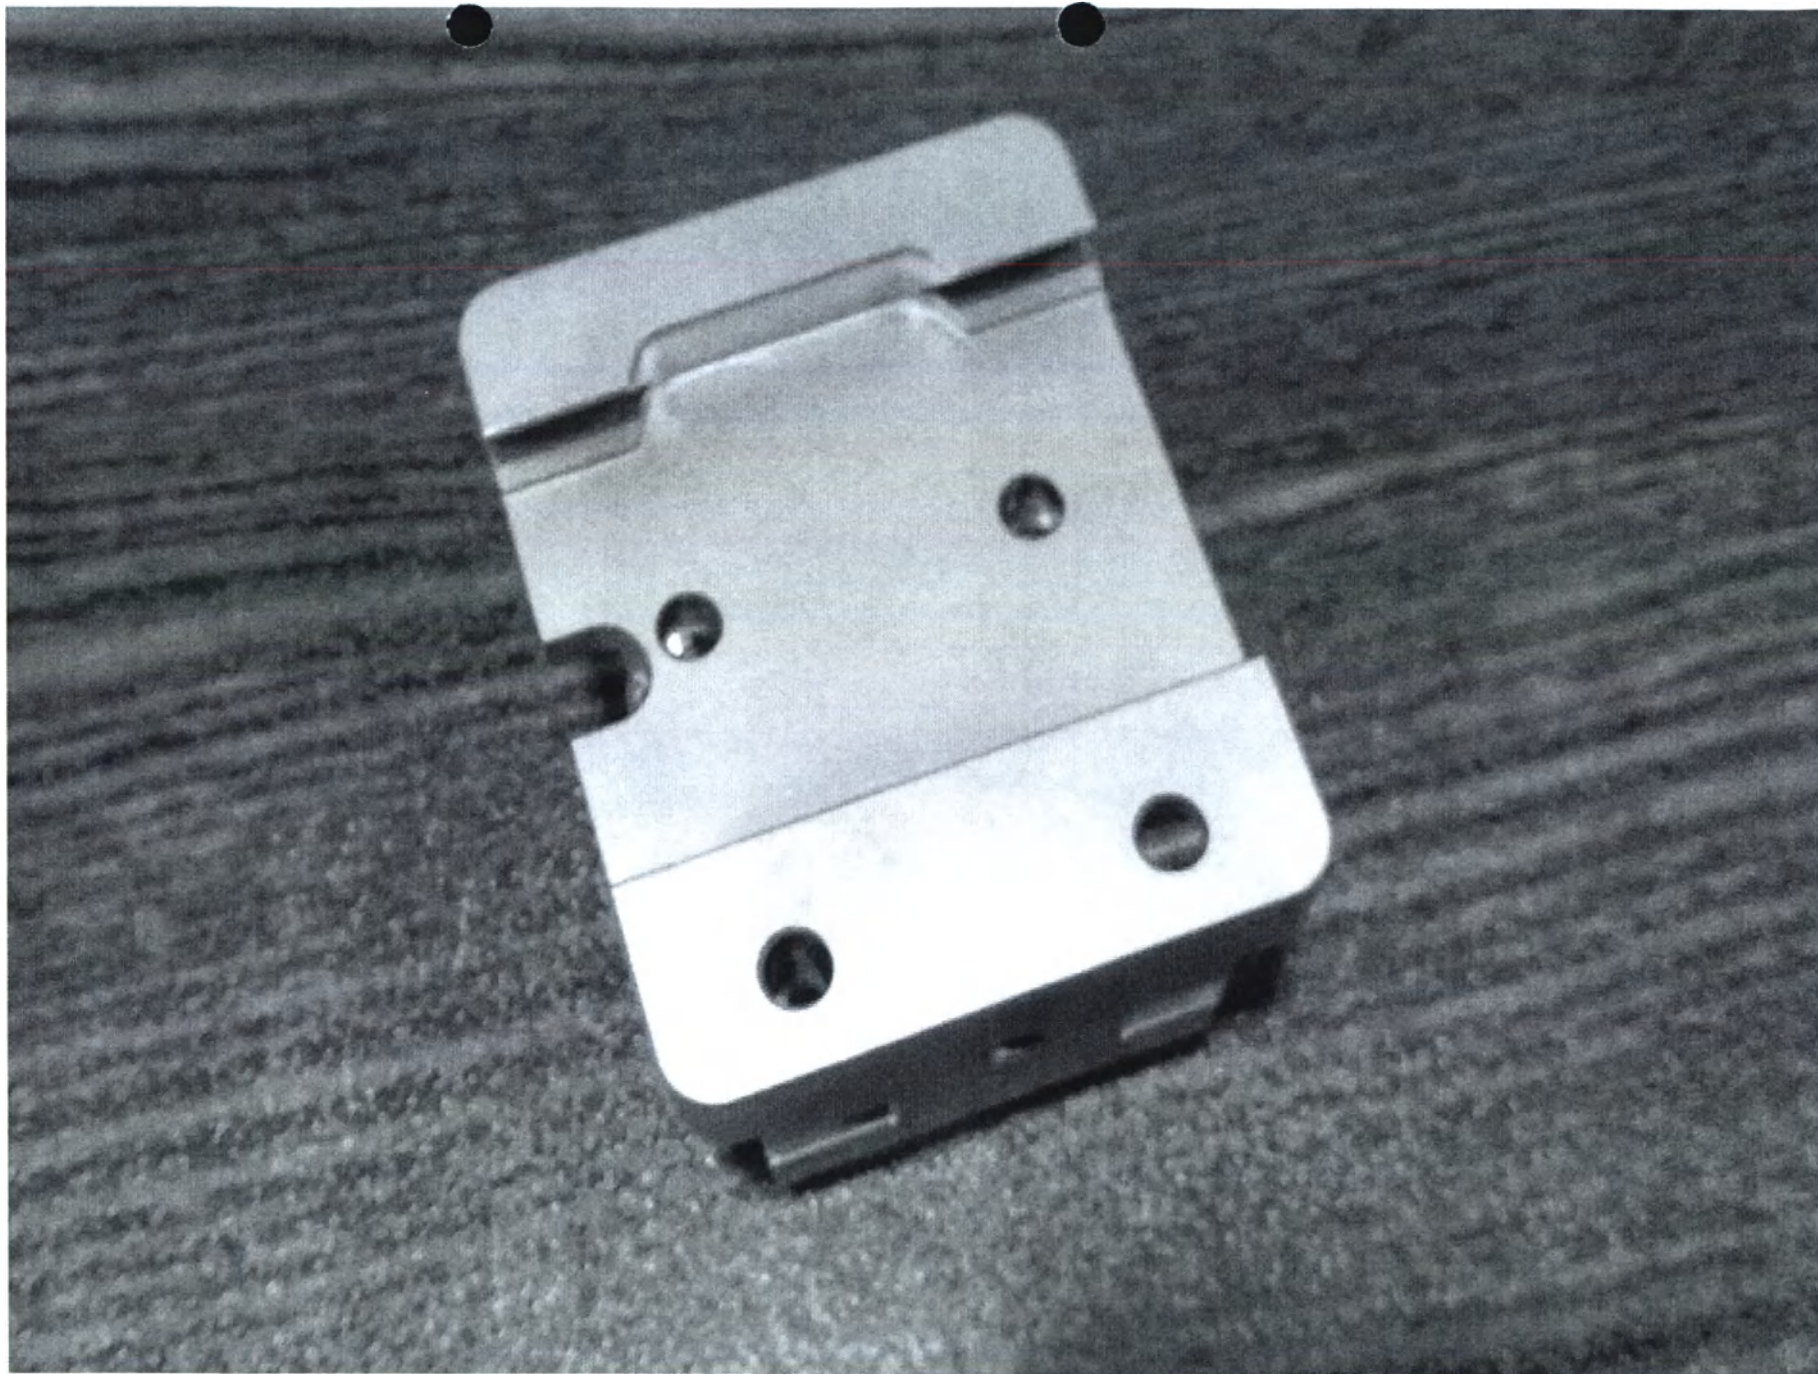


15. Система быстрого зажима образца (Quick clamping system)




16. Зажим кассетный универсальный (Universal cassette clamp)

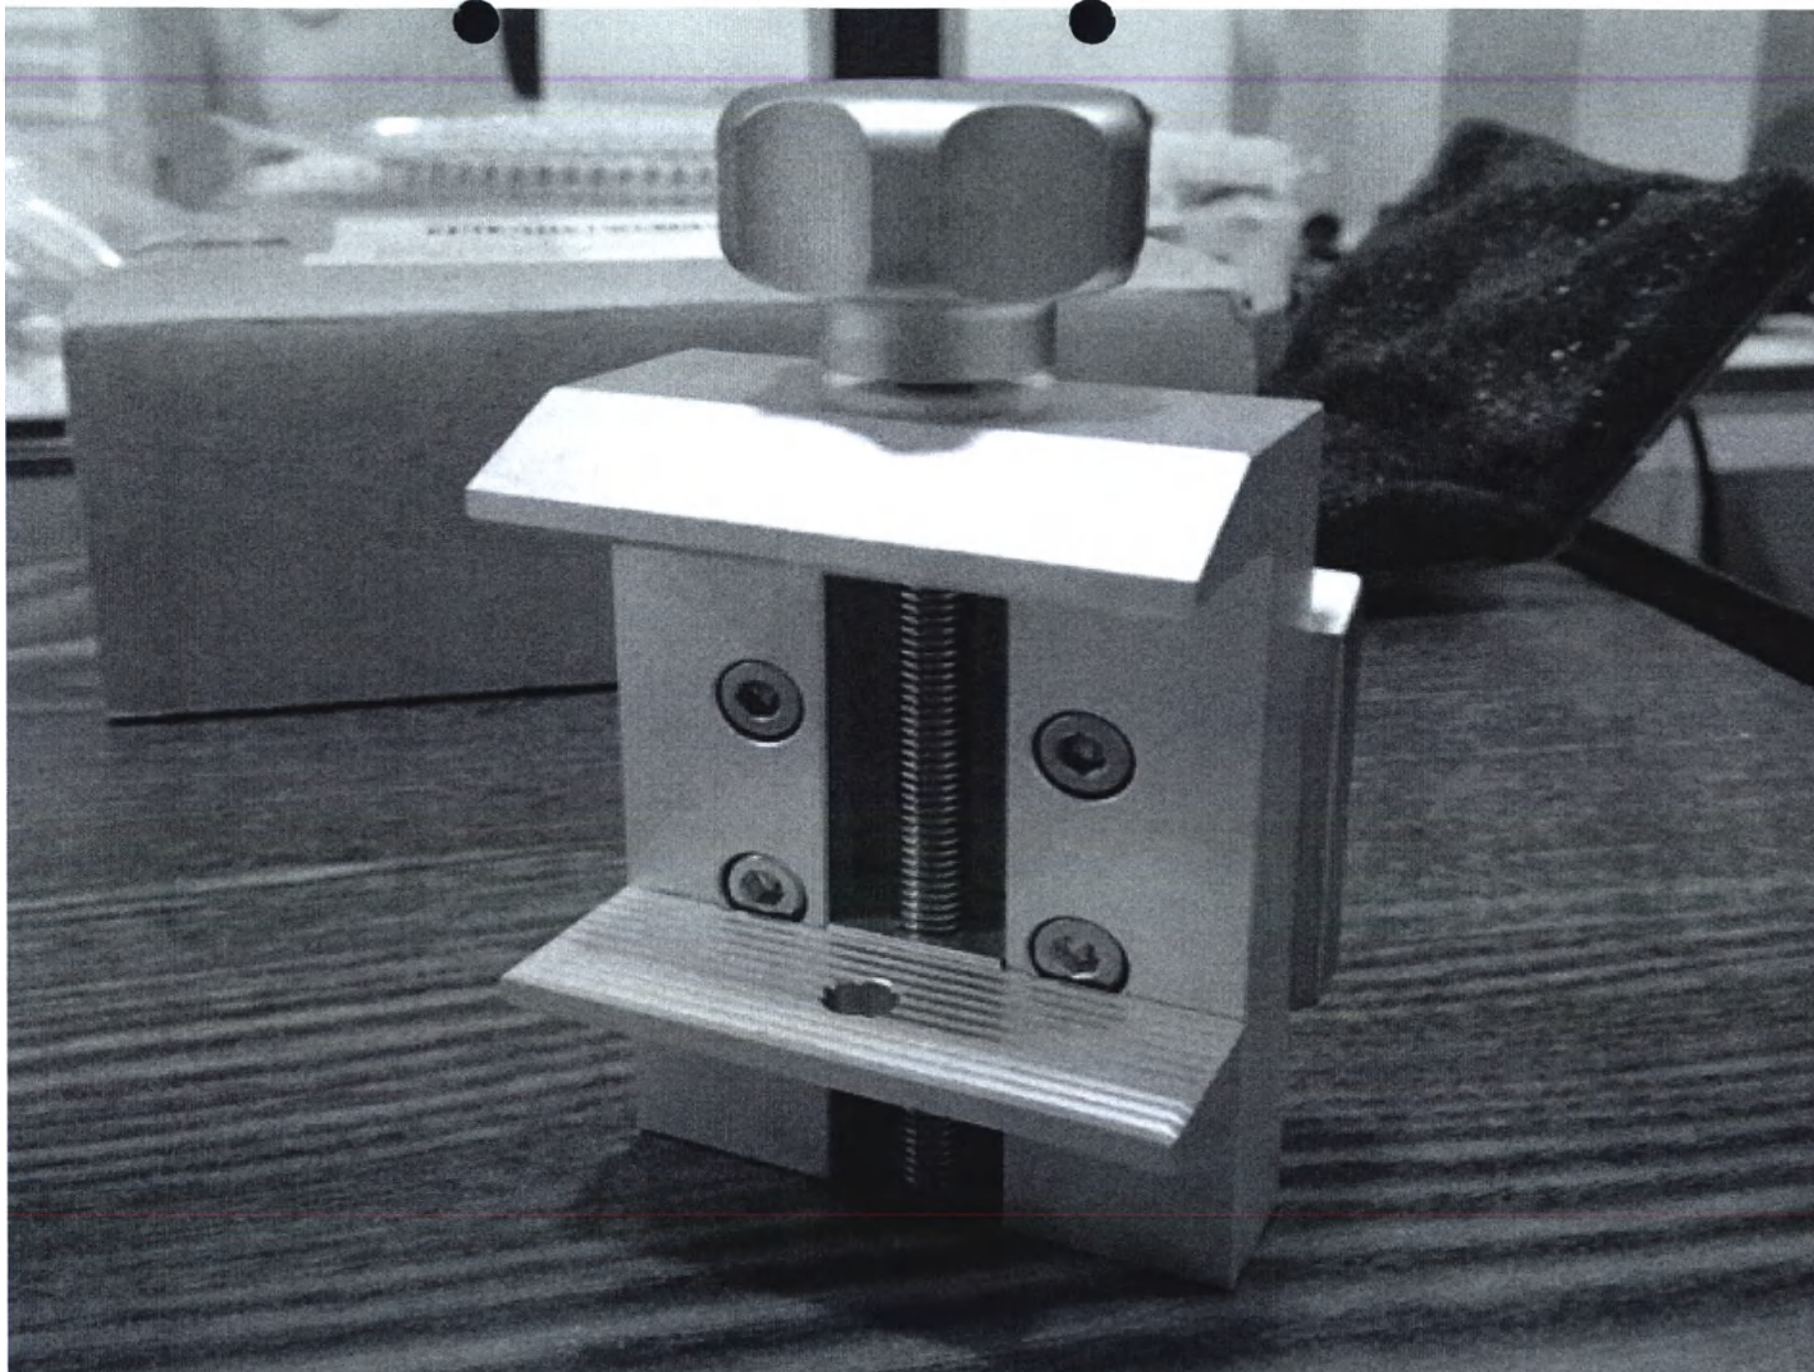


17. Зажим образца стандартный, 50×55 мм (Standard specimen clamp 50×55 mm)

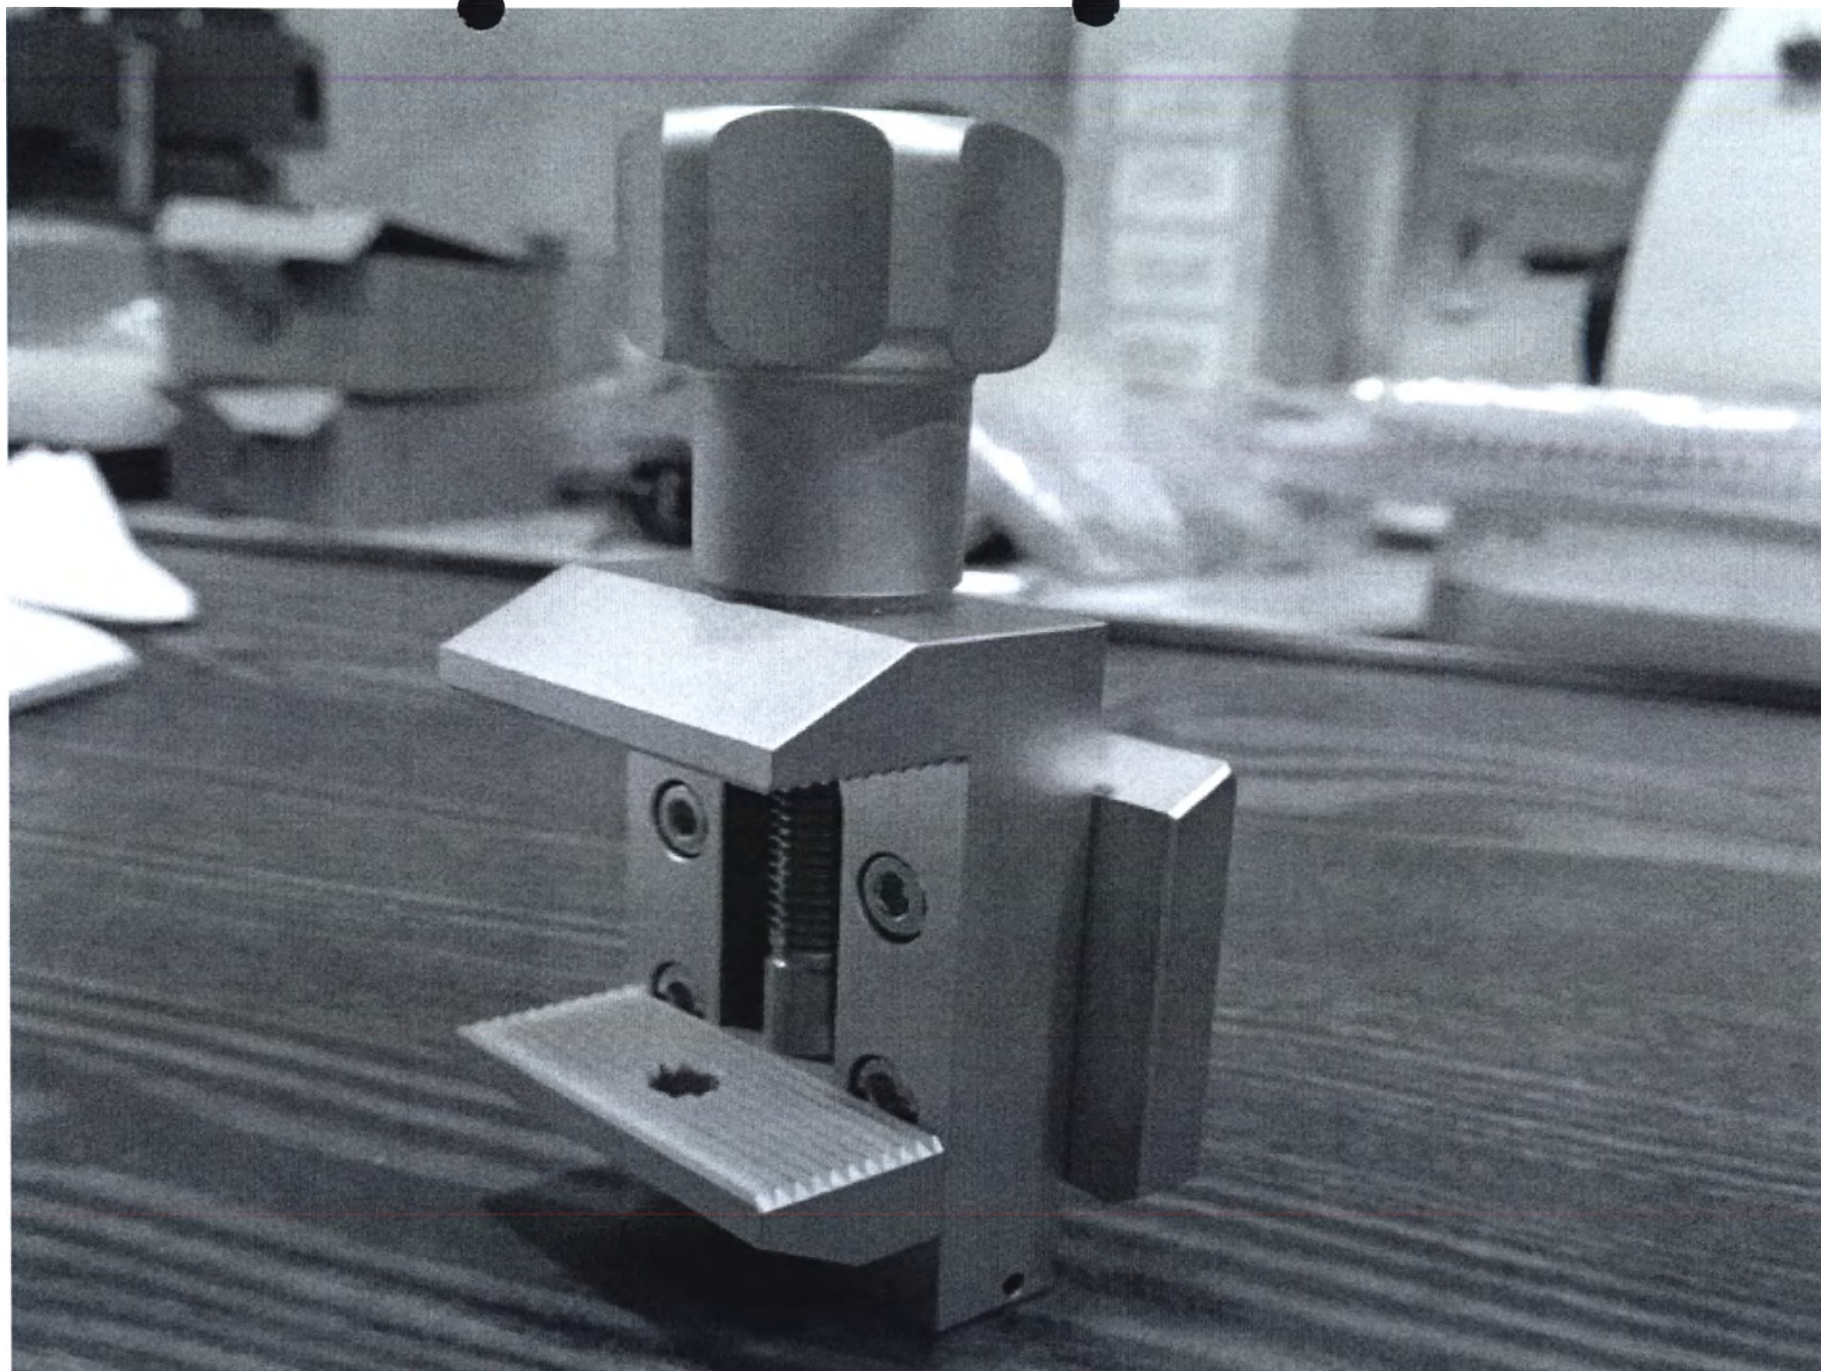


18. Зажим образца стандартный, 40×40 мм (Standard specimen clamp 40×40 mm)

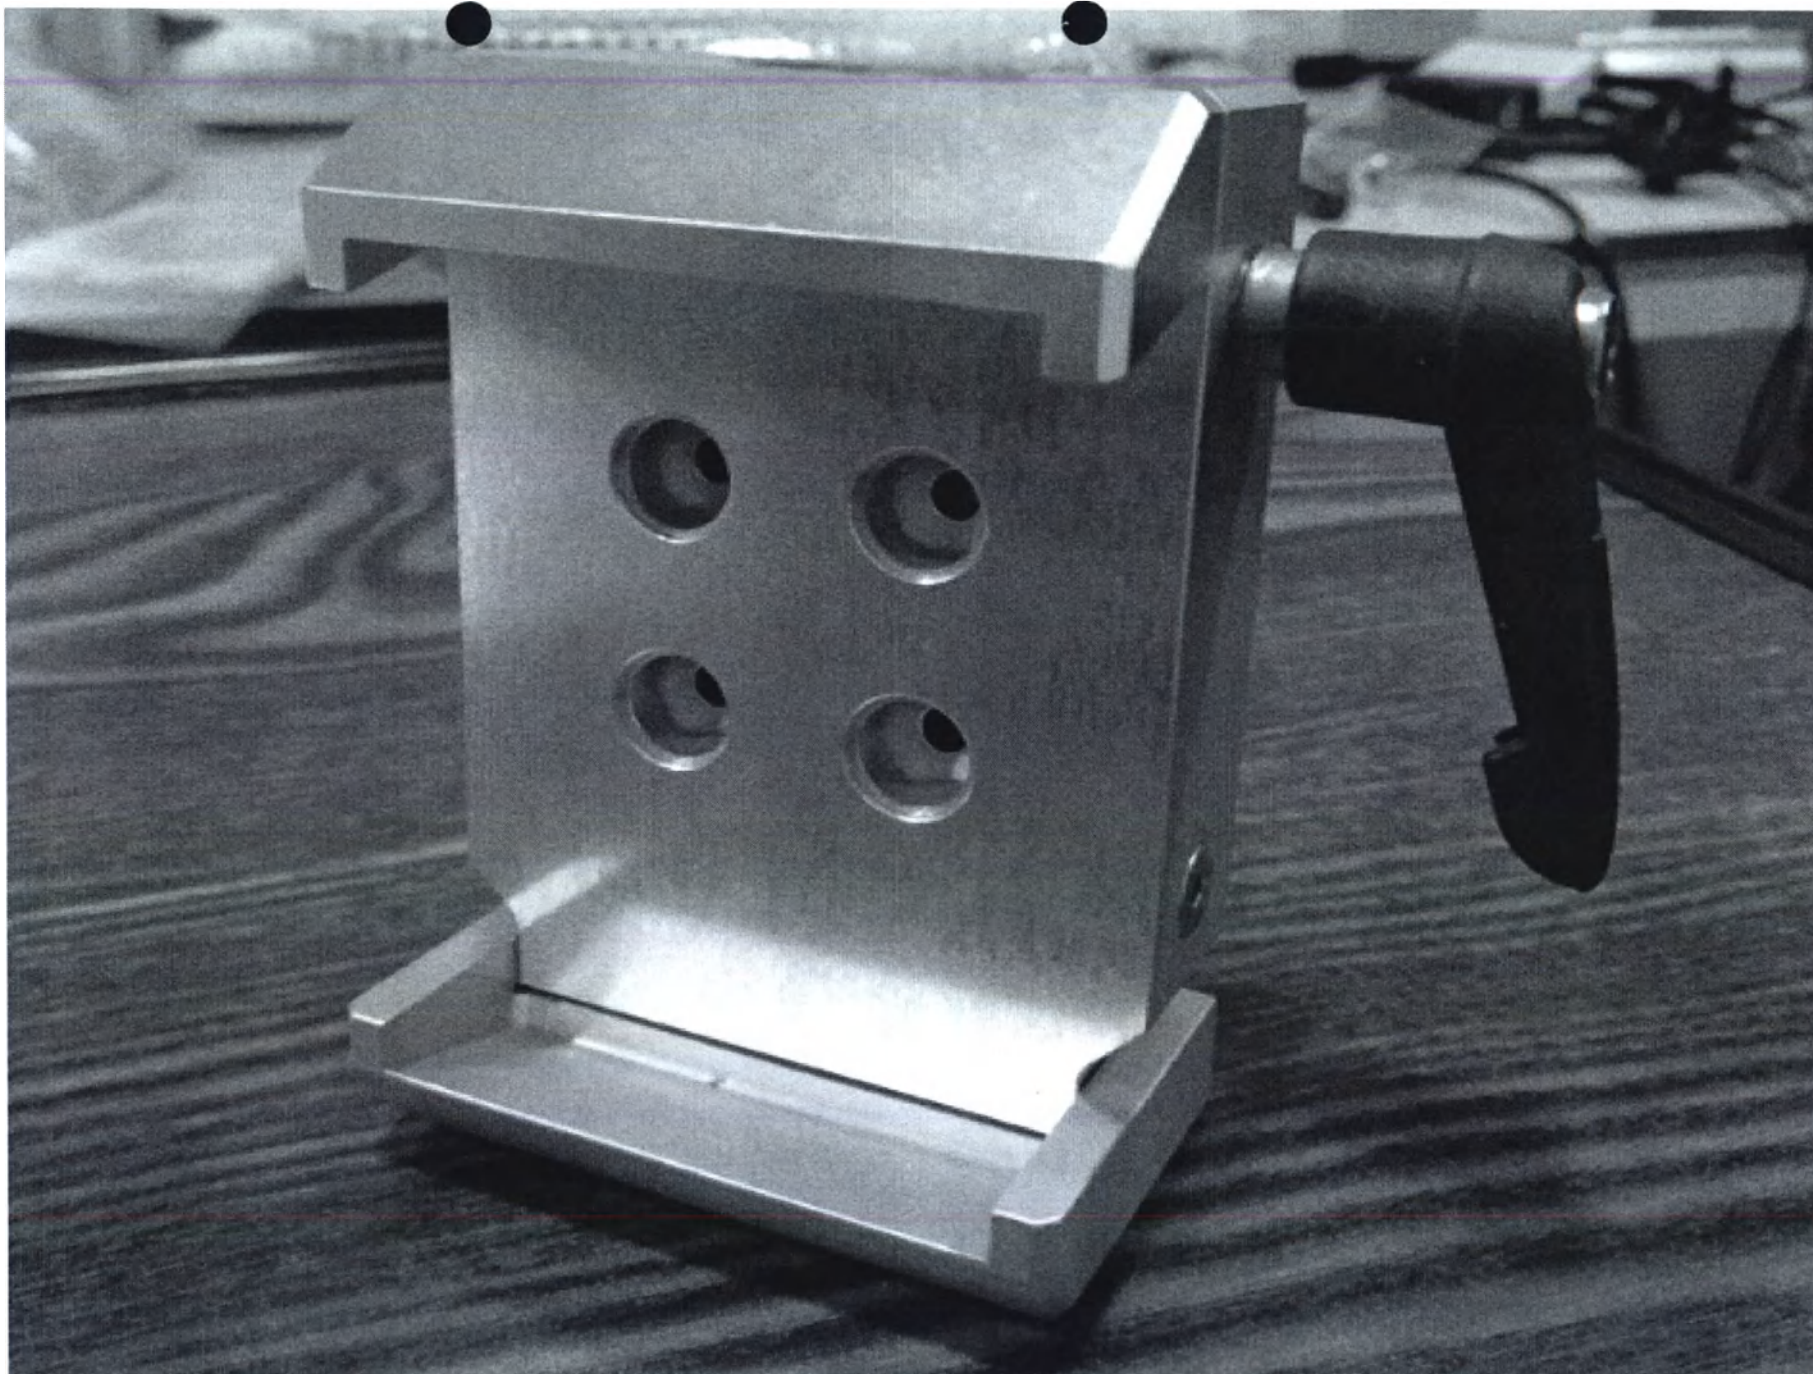


19. Зажим кассетный «Супер» (Super cassette clamp)

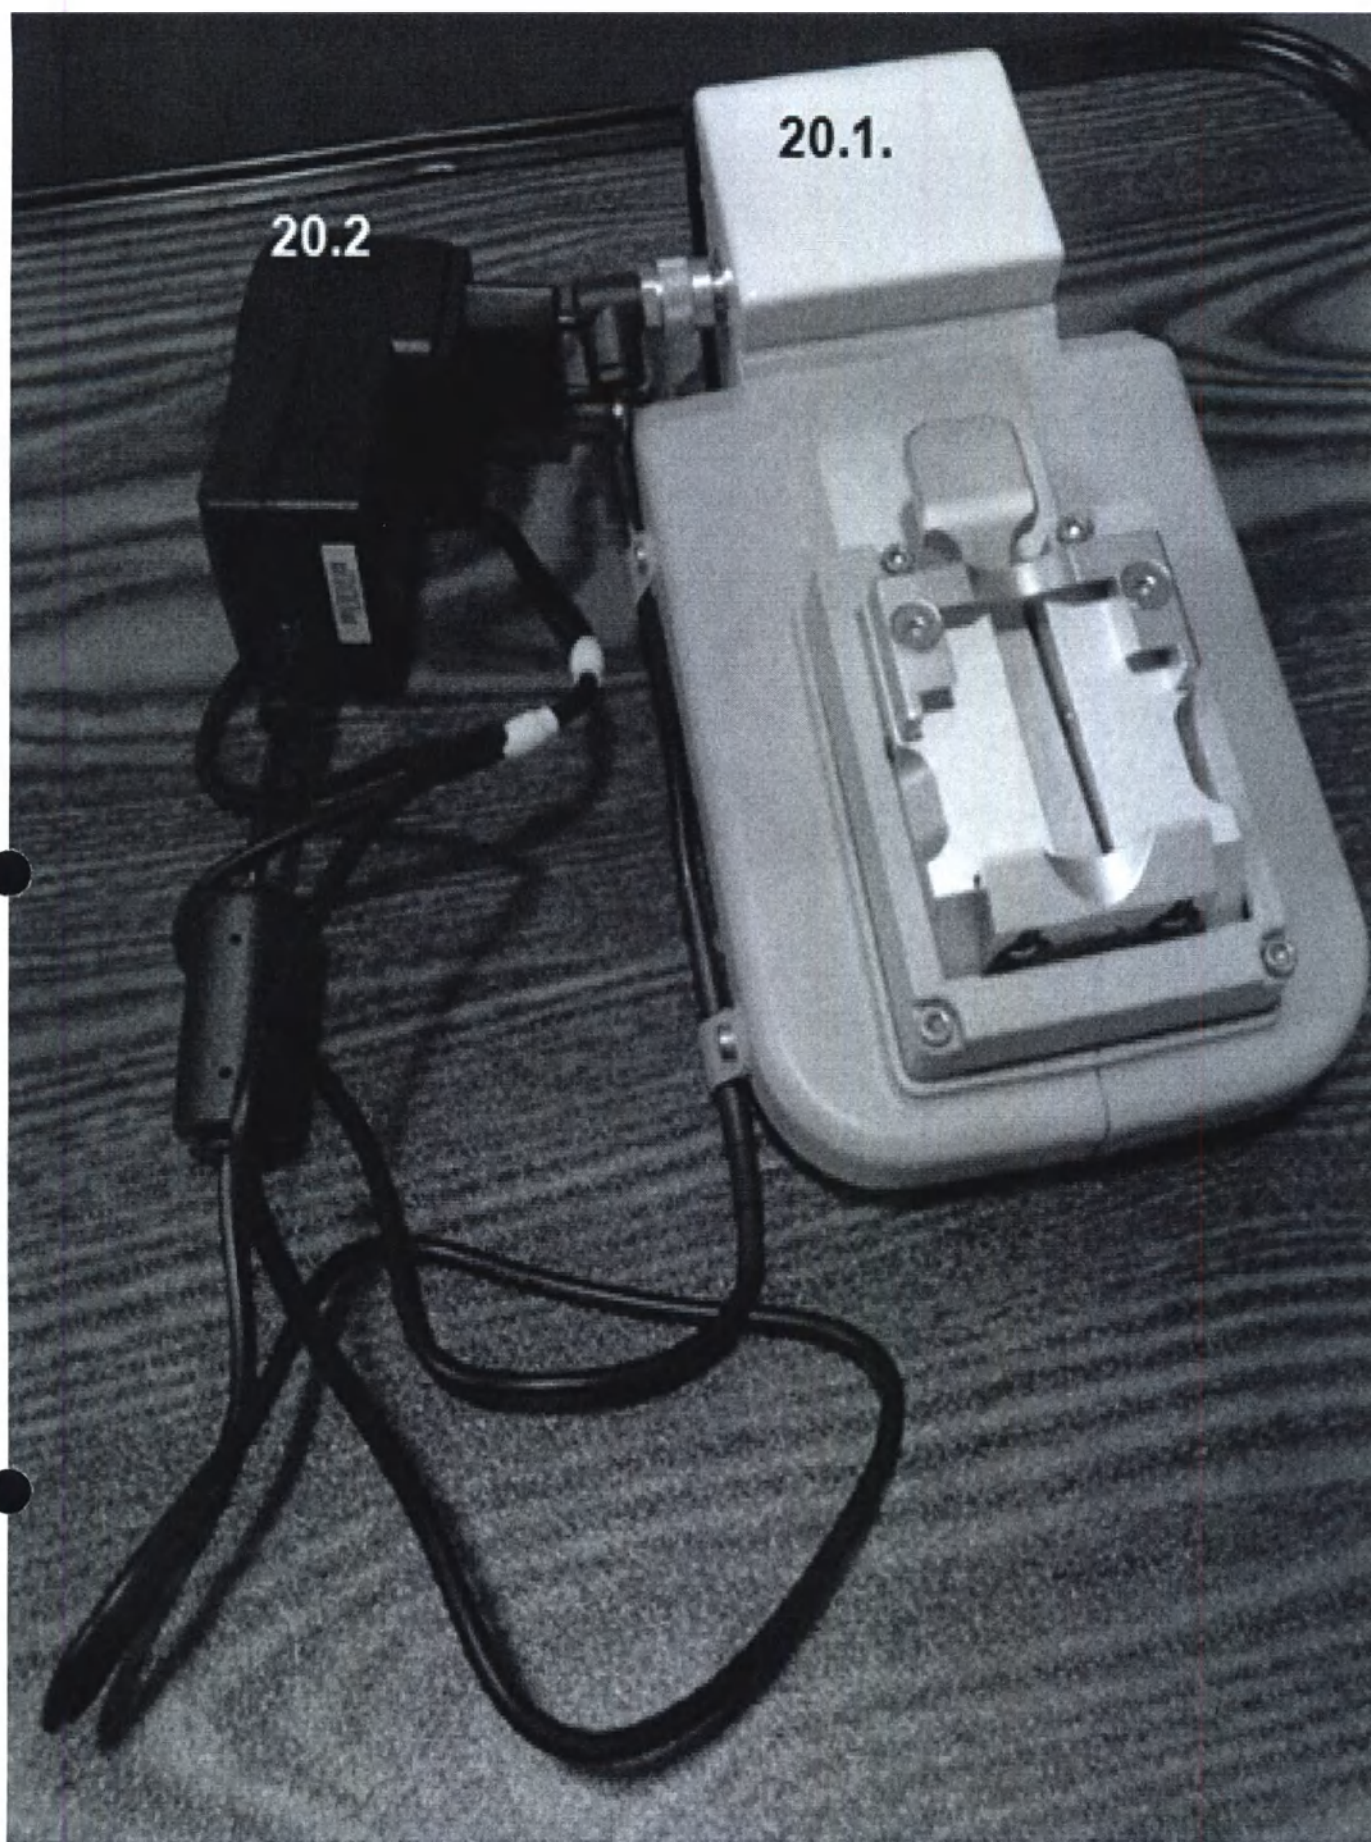


20. Зажим кассетный универсальный с охлаждением CoolClamp (RM CoolClamp), в составе:
20.1. Зажим кассетный универсальный с охлаждением CoolClamp;
20.2. Блок питания (Power supply) - 1

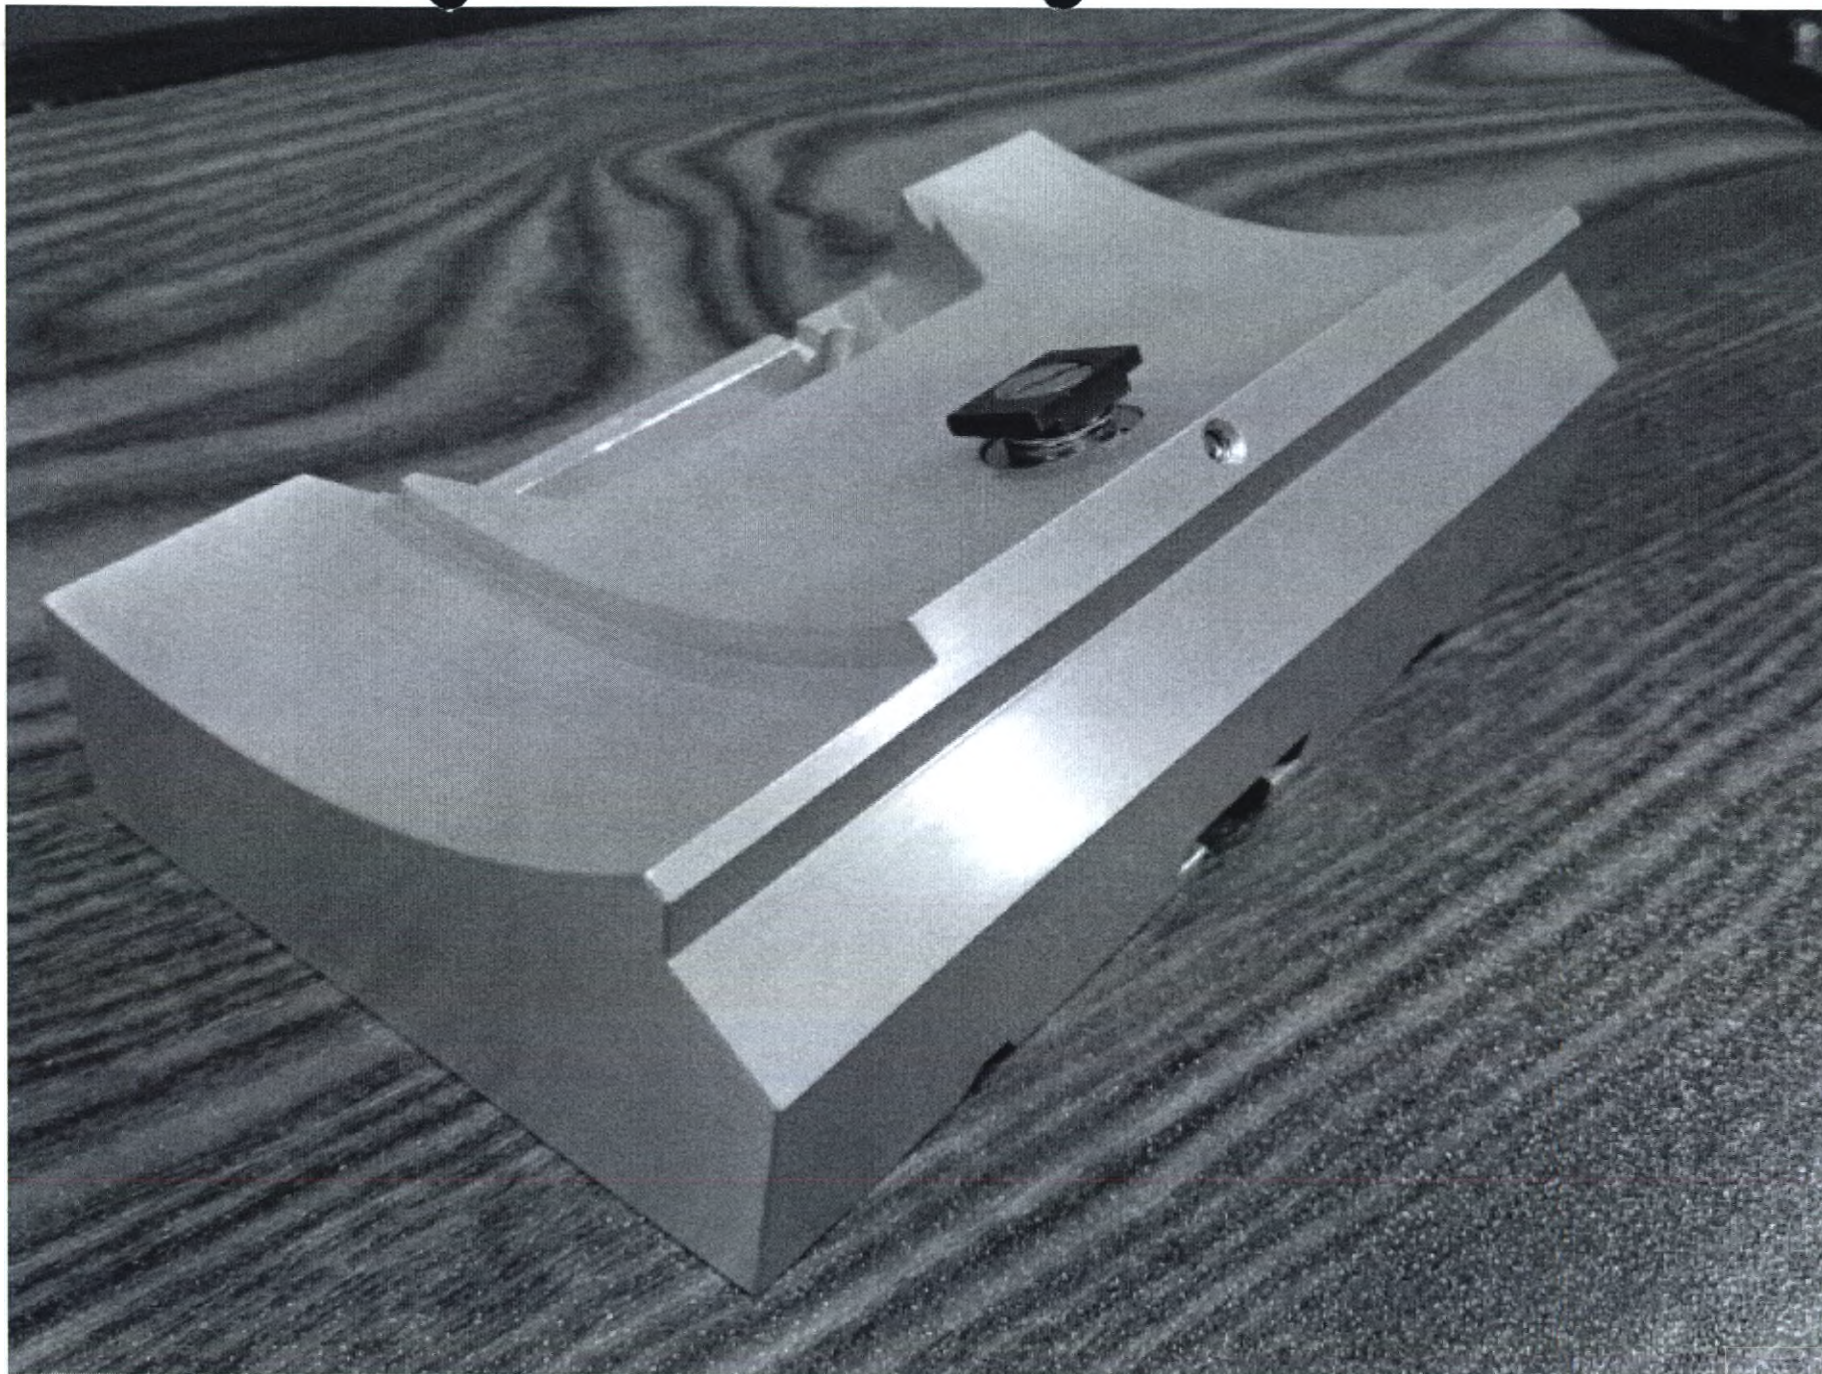


21. Основание держателя лезвия (Blade holder base)

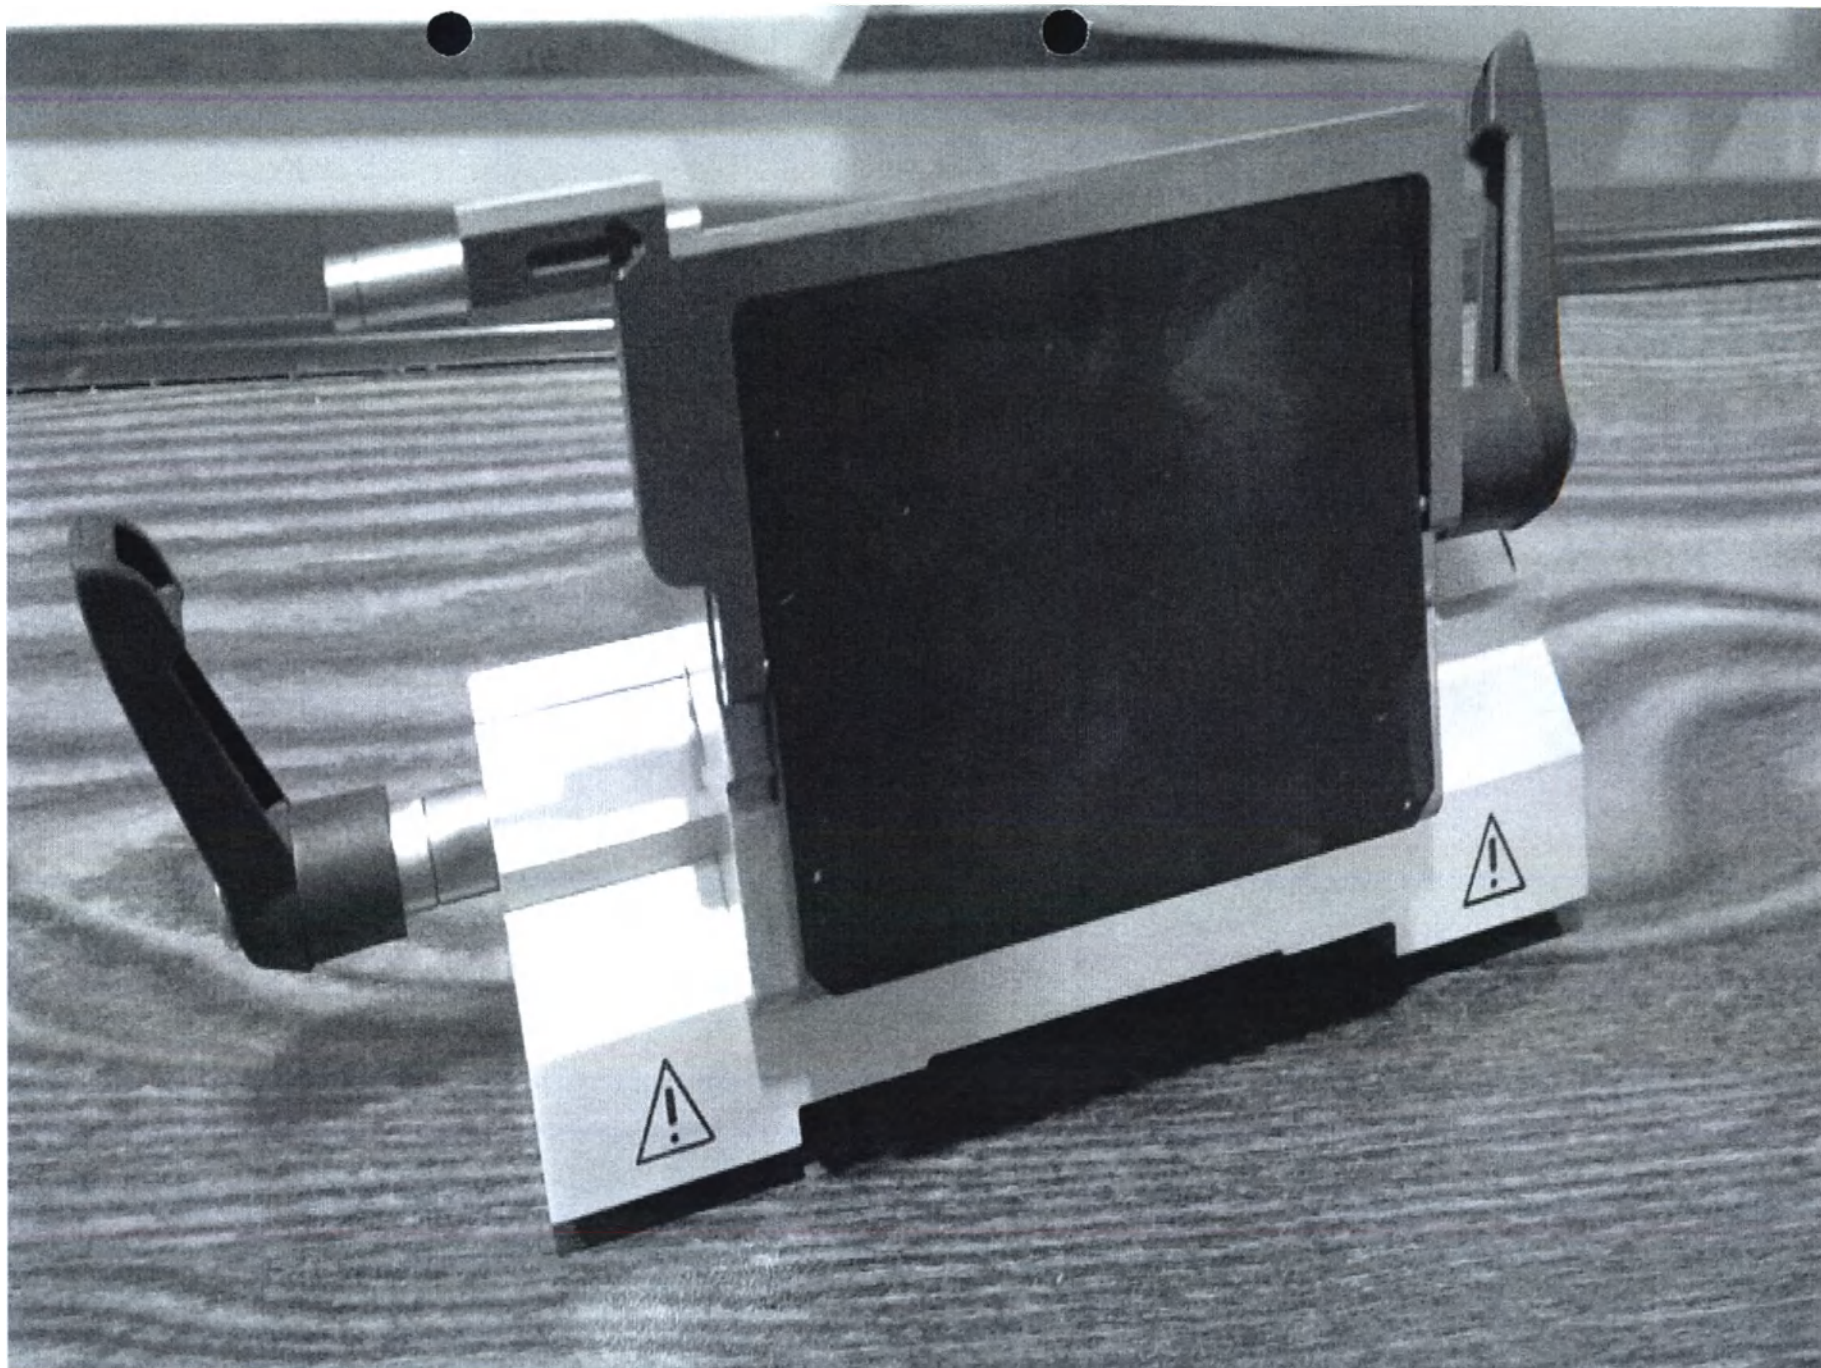


22. Держатель лезвия универсальный Е (2-in-1 Blade holder E)

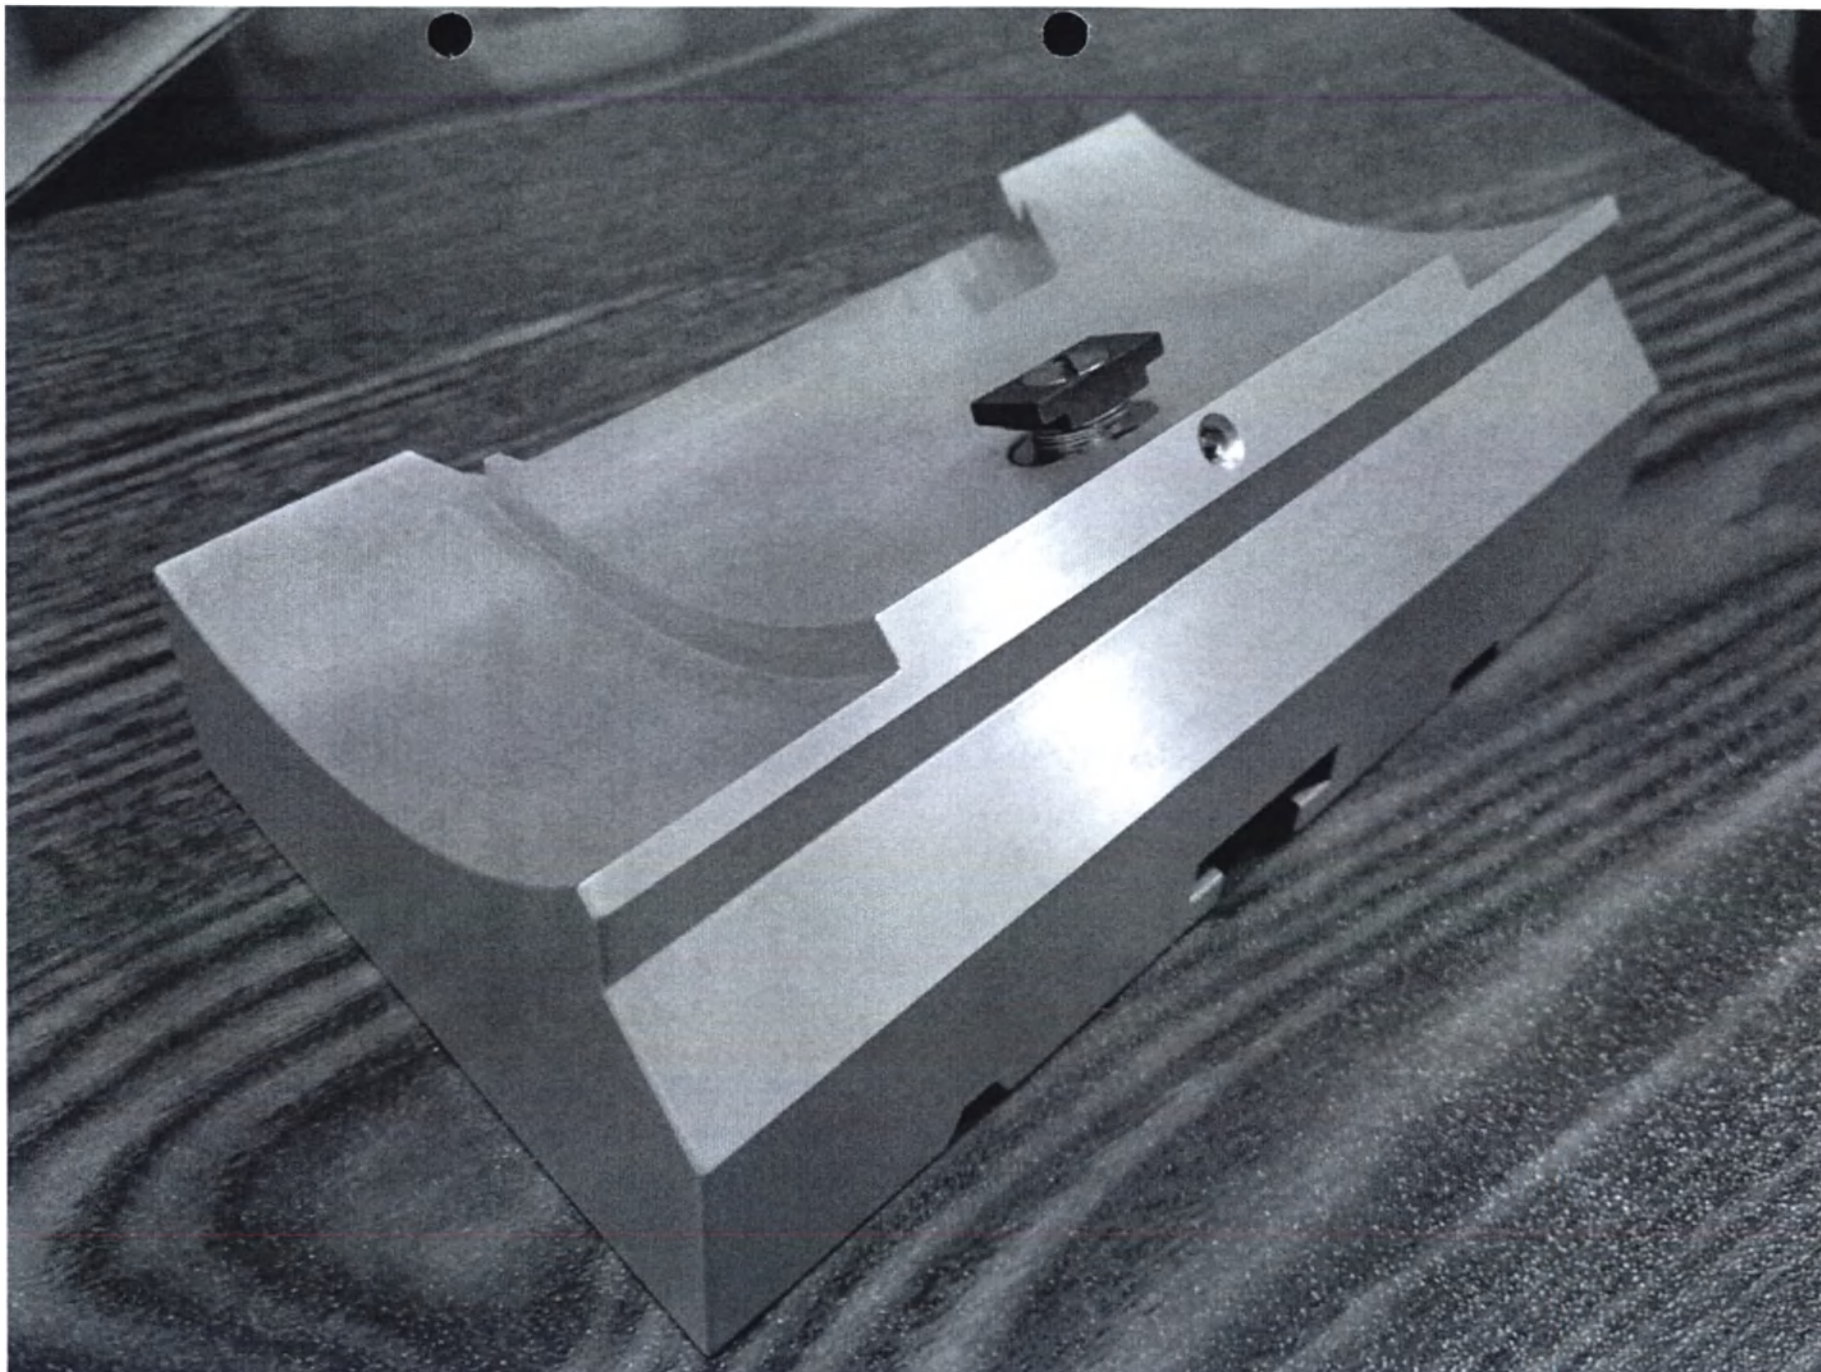

23. Основание держателя ножа (Knife holder base)

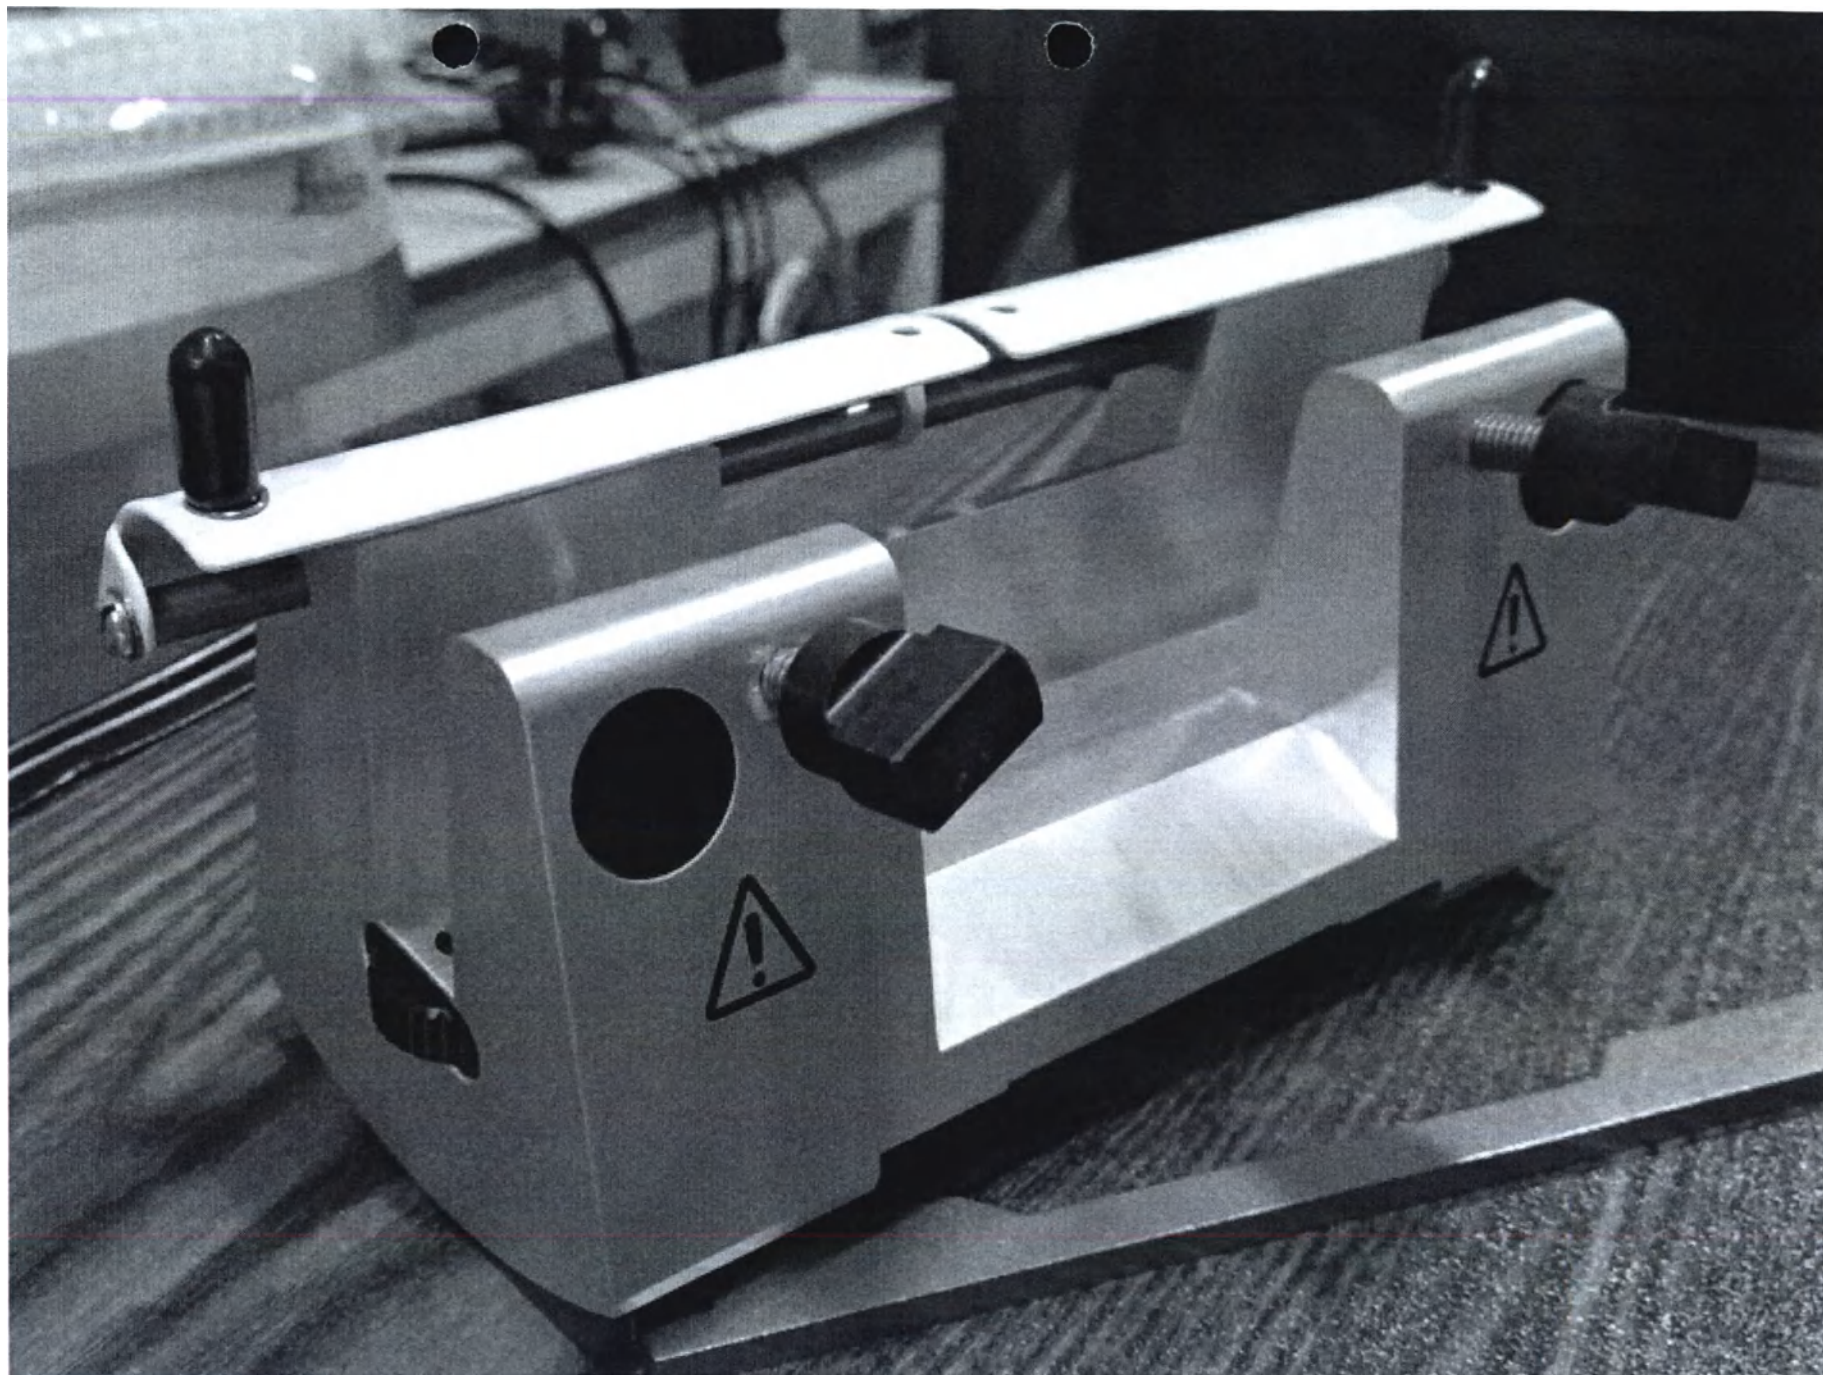

24. Держатель ножа N (Knife holder N)

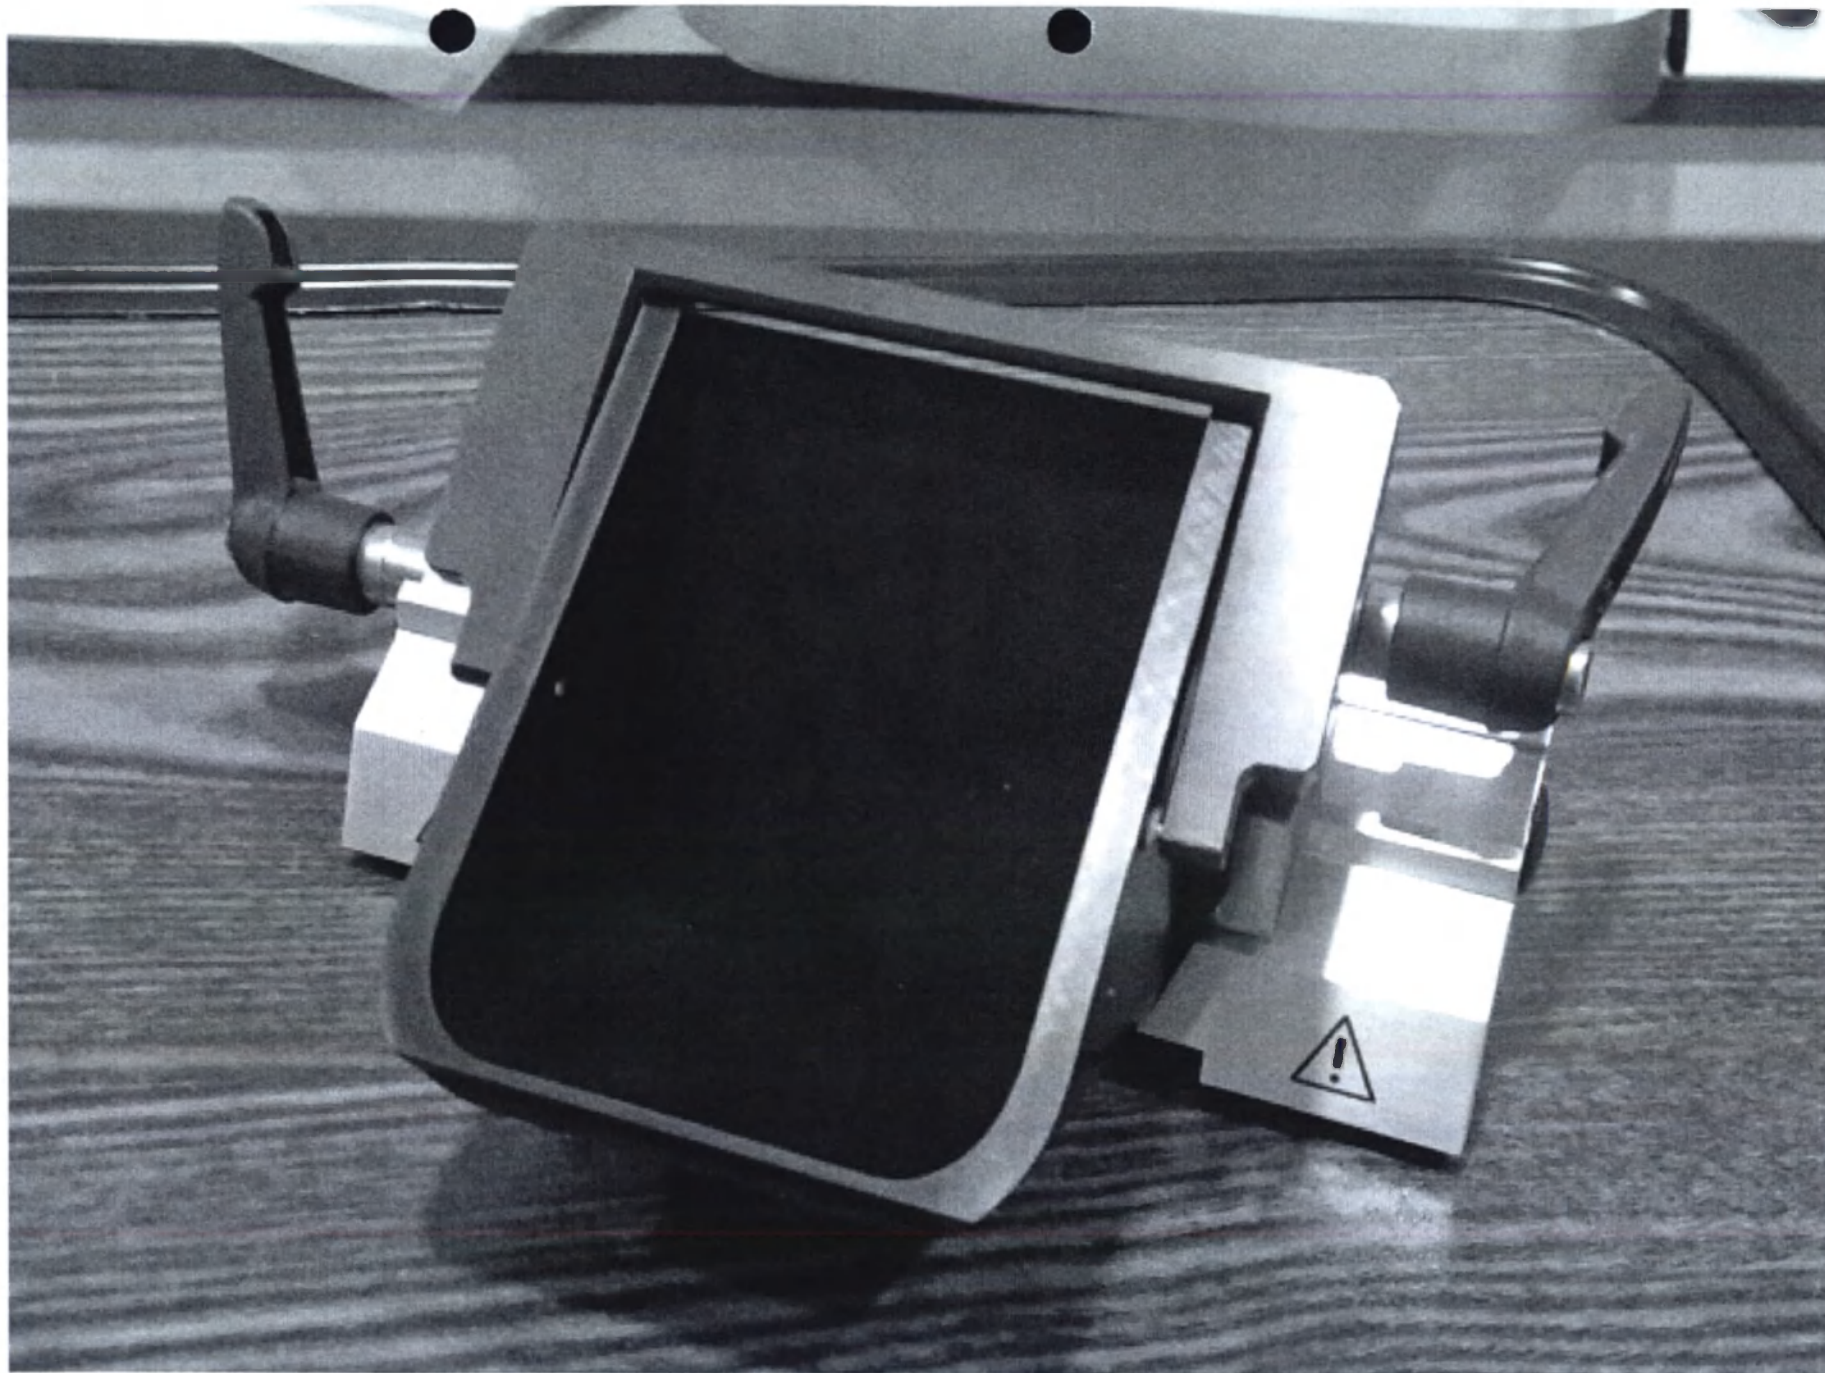


25. Держатель ножа Е с ванночкой, для лезвий низкого профиля (Knife holder E w/trough low-profile)




26. Лезвия одноразовые — низкого профиля (80 × 8 × 0,25 мм) (Disposable blades – low-profile)



27. Лезвия одноразовые — высокого профиля (80 × 14 × 0,35 мм) (Disposable blades – high-profile)

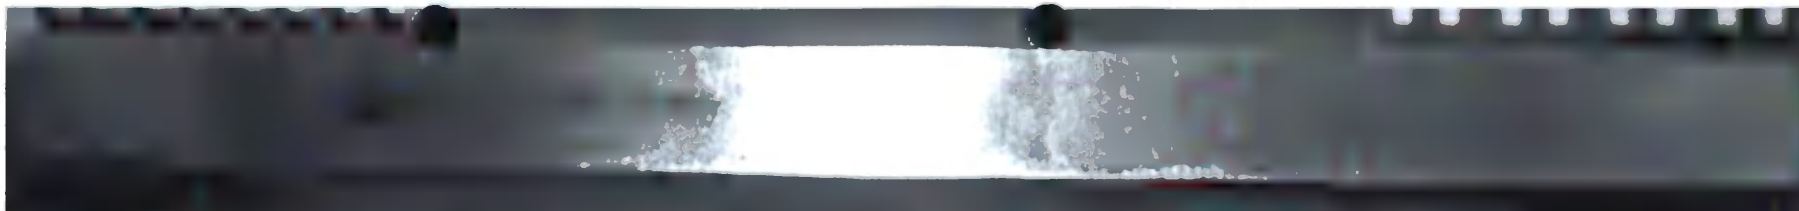

28. Нож стальной длиной 16 см, профиль "с" (Knife 16 cm - profile c – steel)

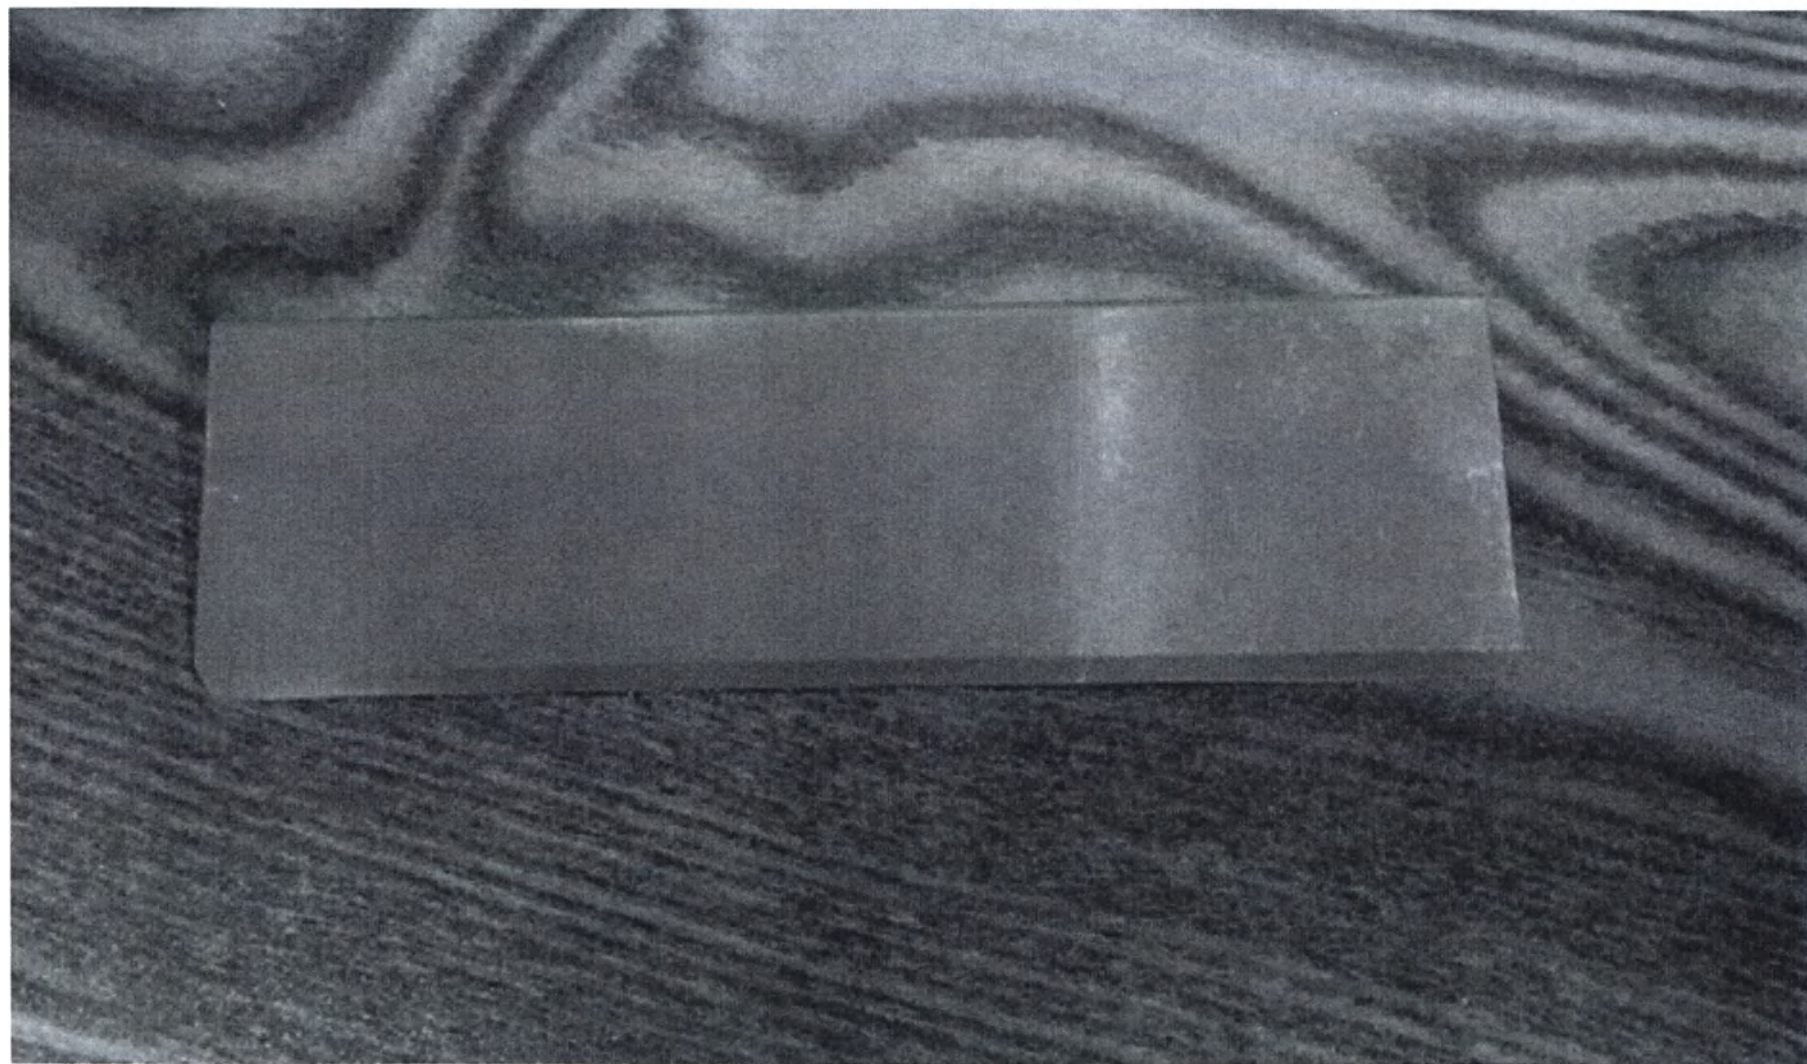


29. Нож стальной длиной 16 см, профиль "d" (Knife 16 cm - profile d – steel)



30. Кабель питания (Power cord)


9/

III. Принадлежности:

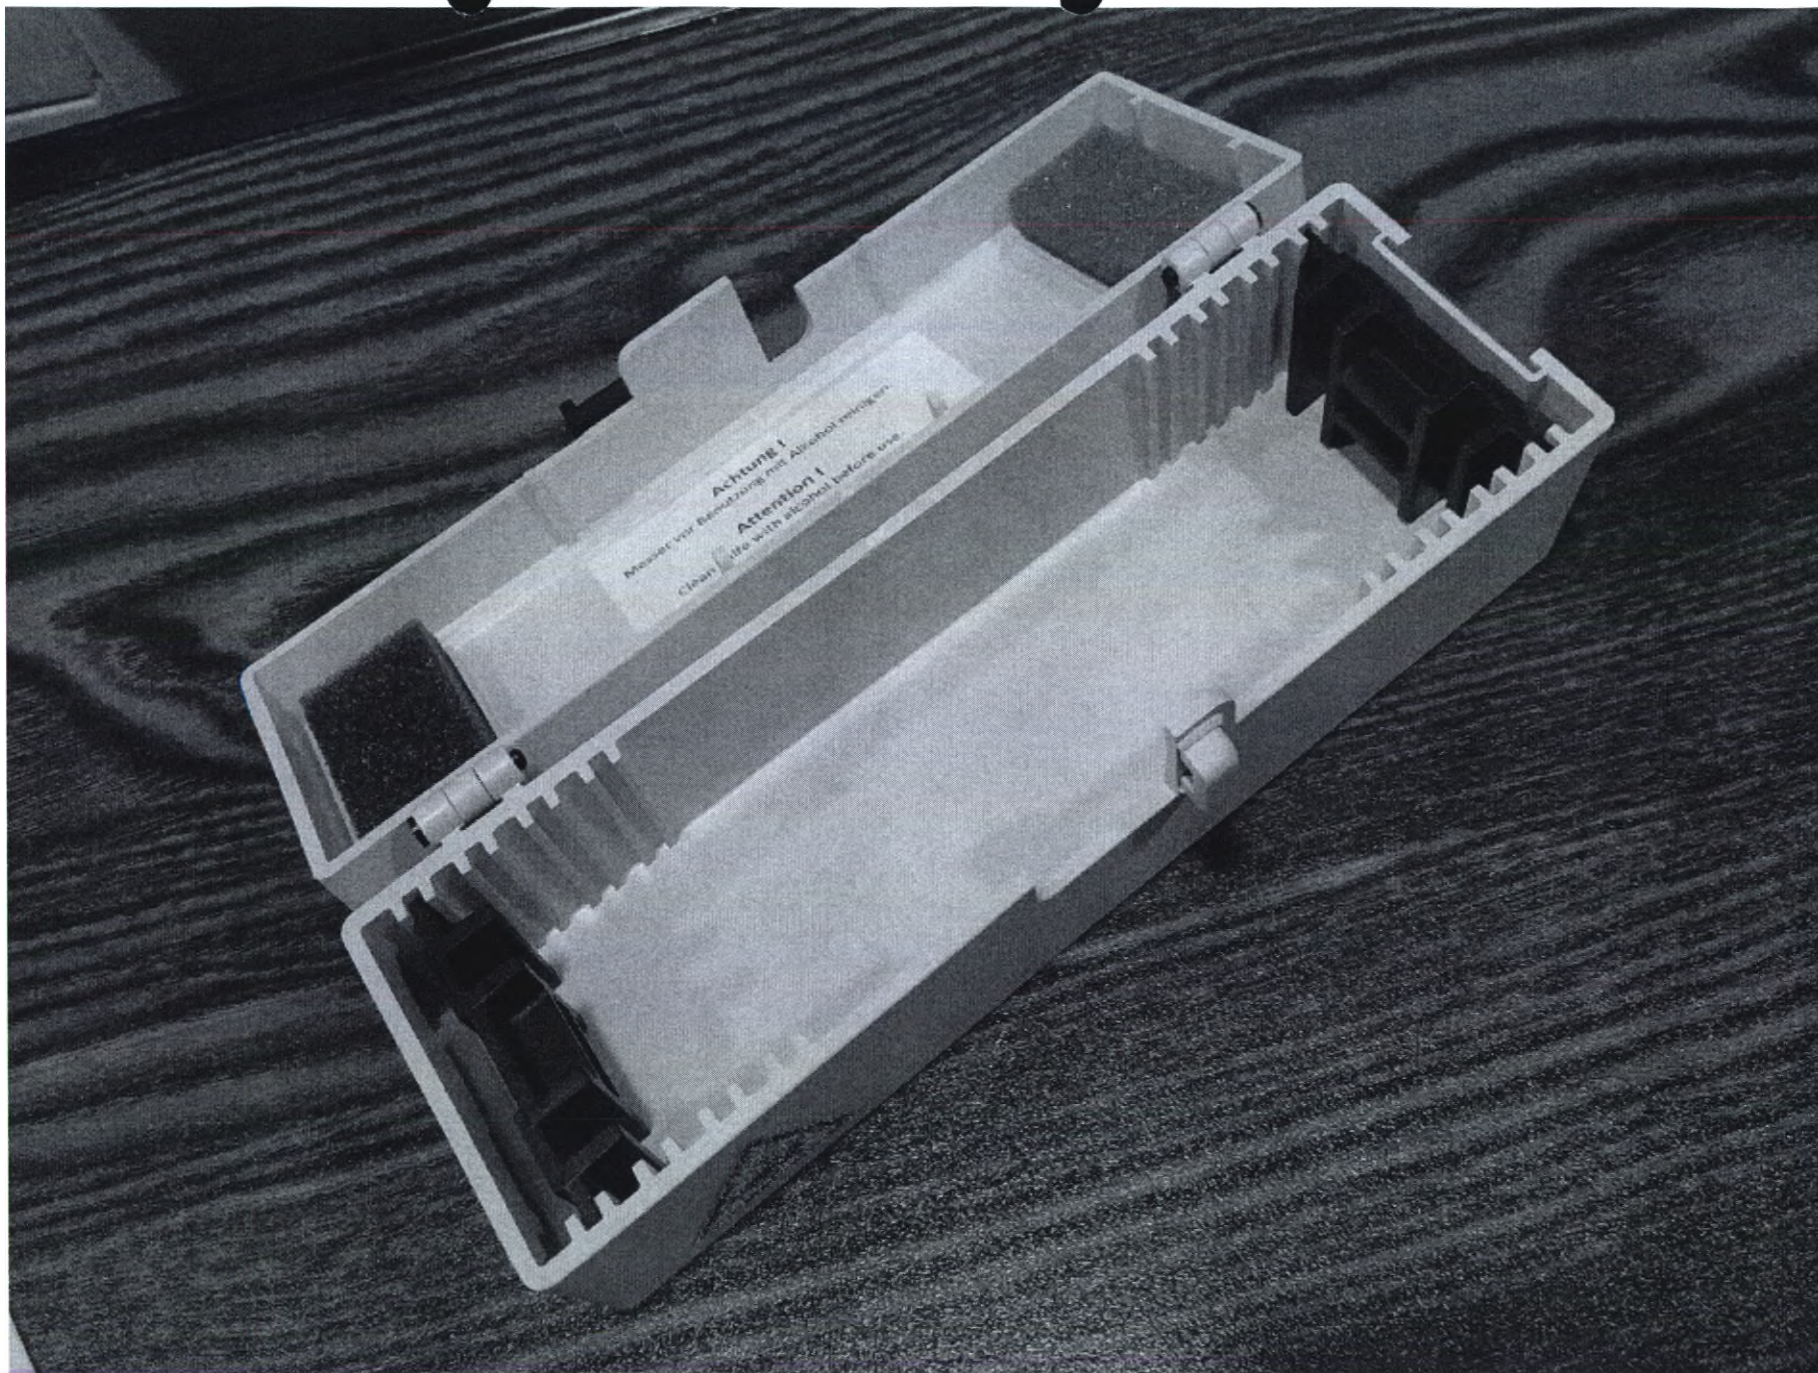



2. Увеличитель (Magnifier)

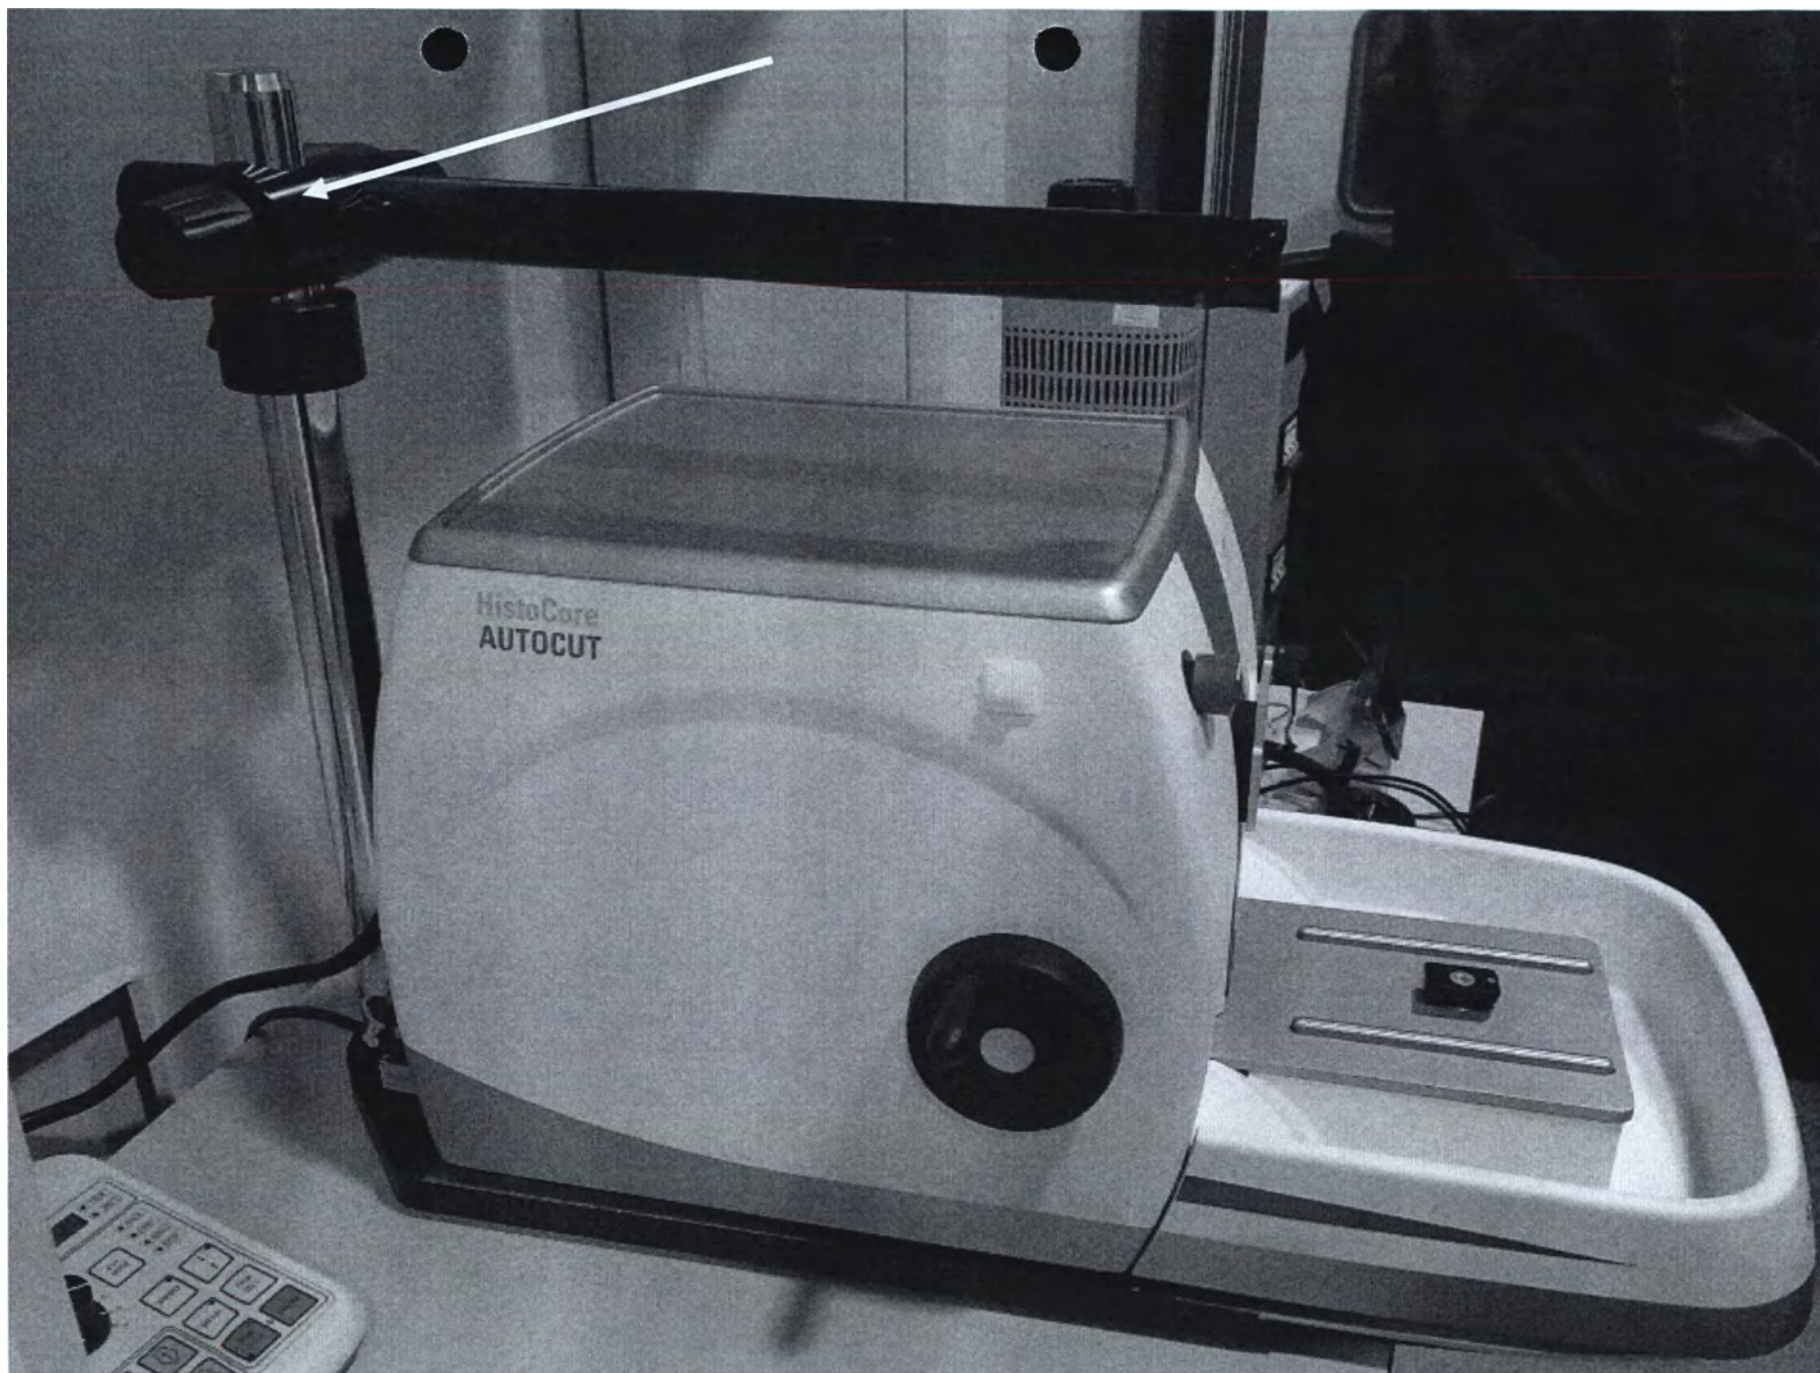

3. Штатив микроскопа универсальный (Universal microscope carrier)



4. Осветитель высокомощный светодиодный 1000 с двумя спотами (LED 1000 Hi-Power spots, 2-arms)


5. Блок управления светодиодами 1000 (LED 1000 control unit), в составе:




5.1.Адаптер питания (Power adapter)




5.2. Контроллер спотов высокой мощности (High-power spot controller)

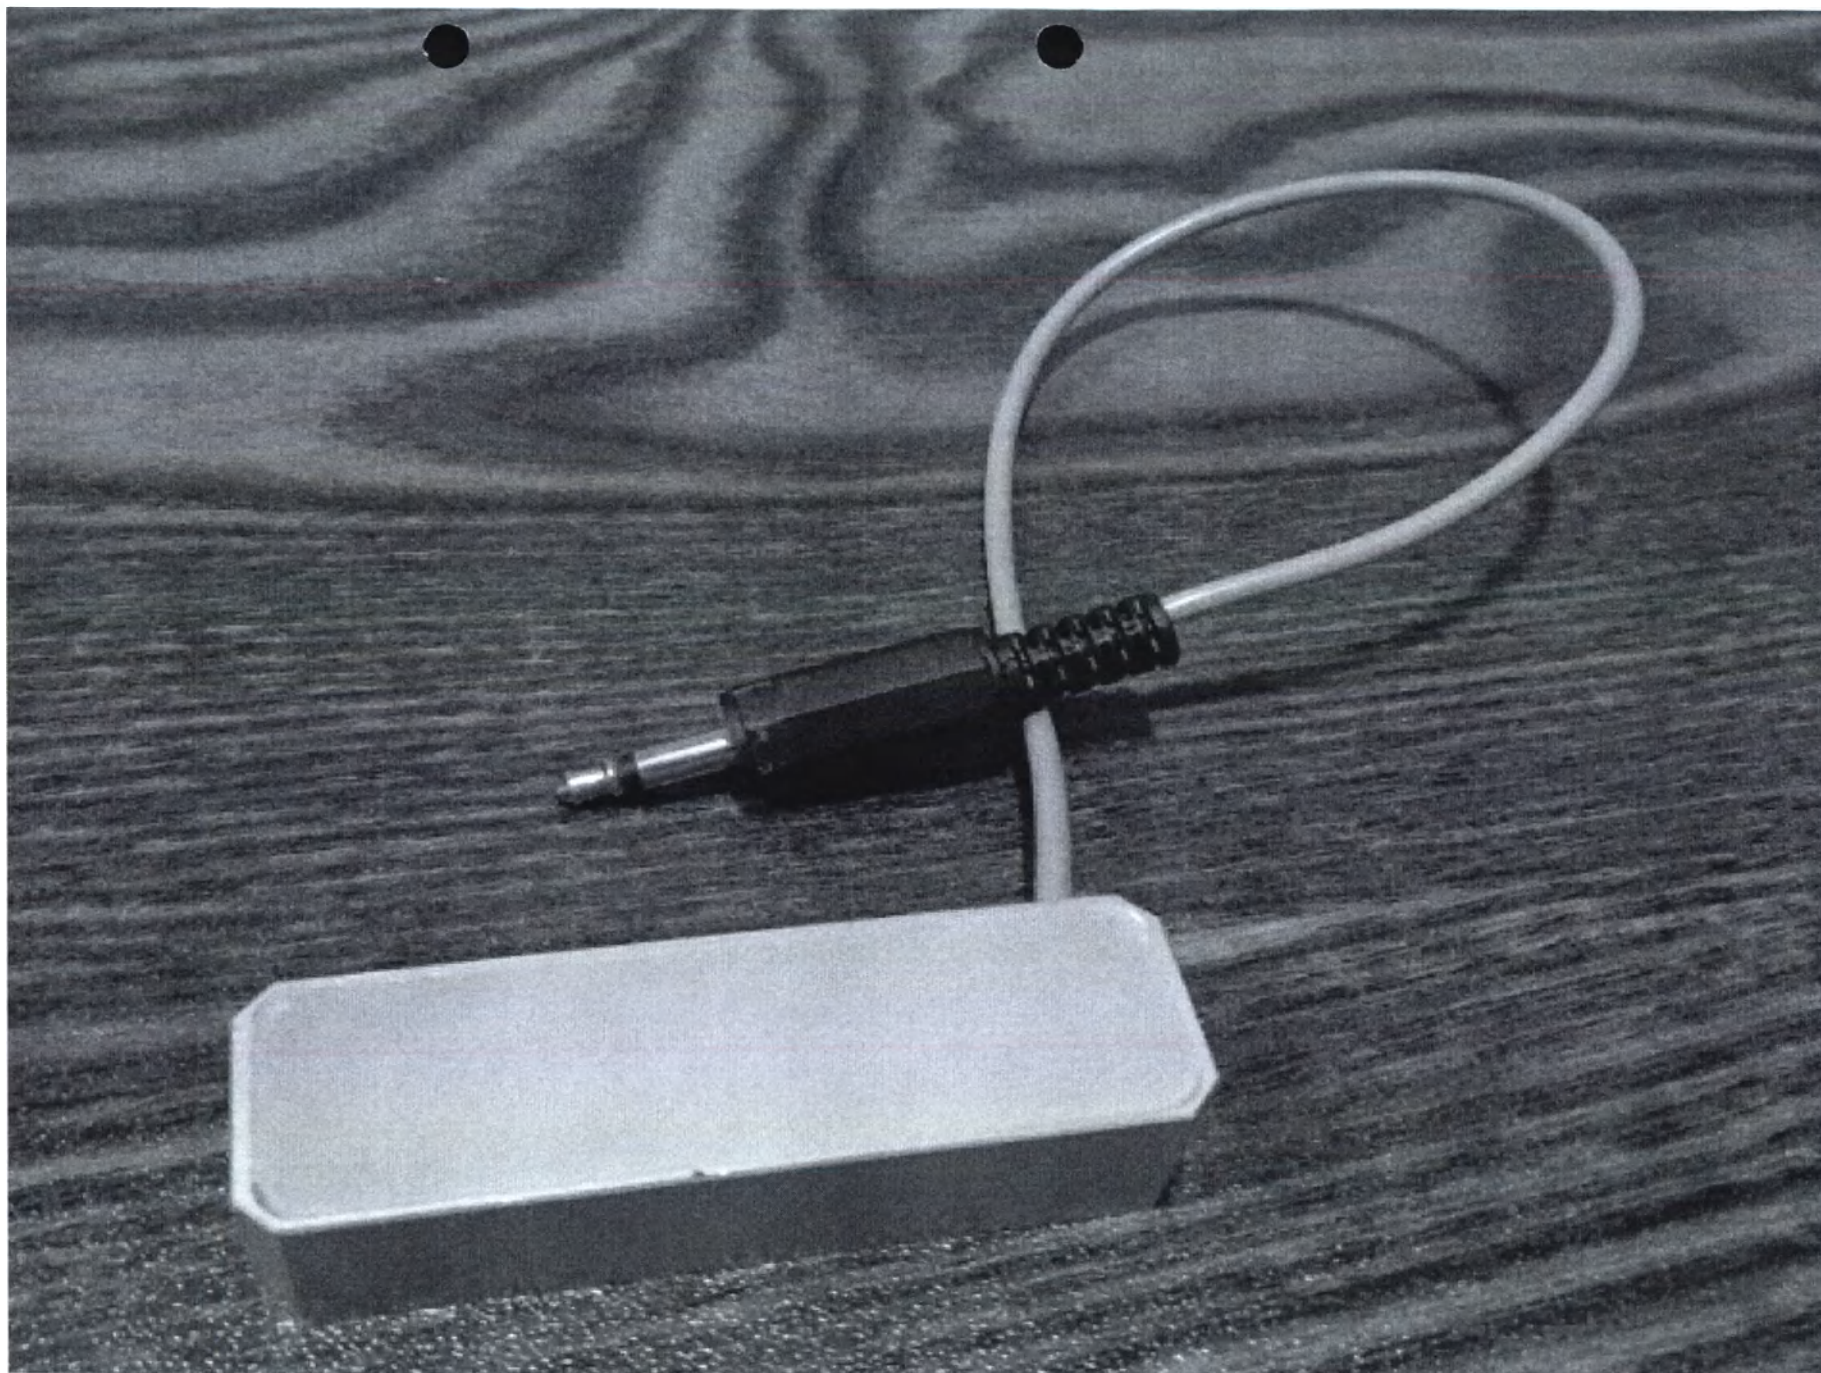

6. Подсветка фоновая (Backlighting)

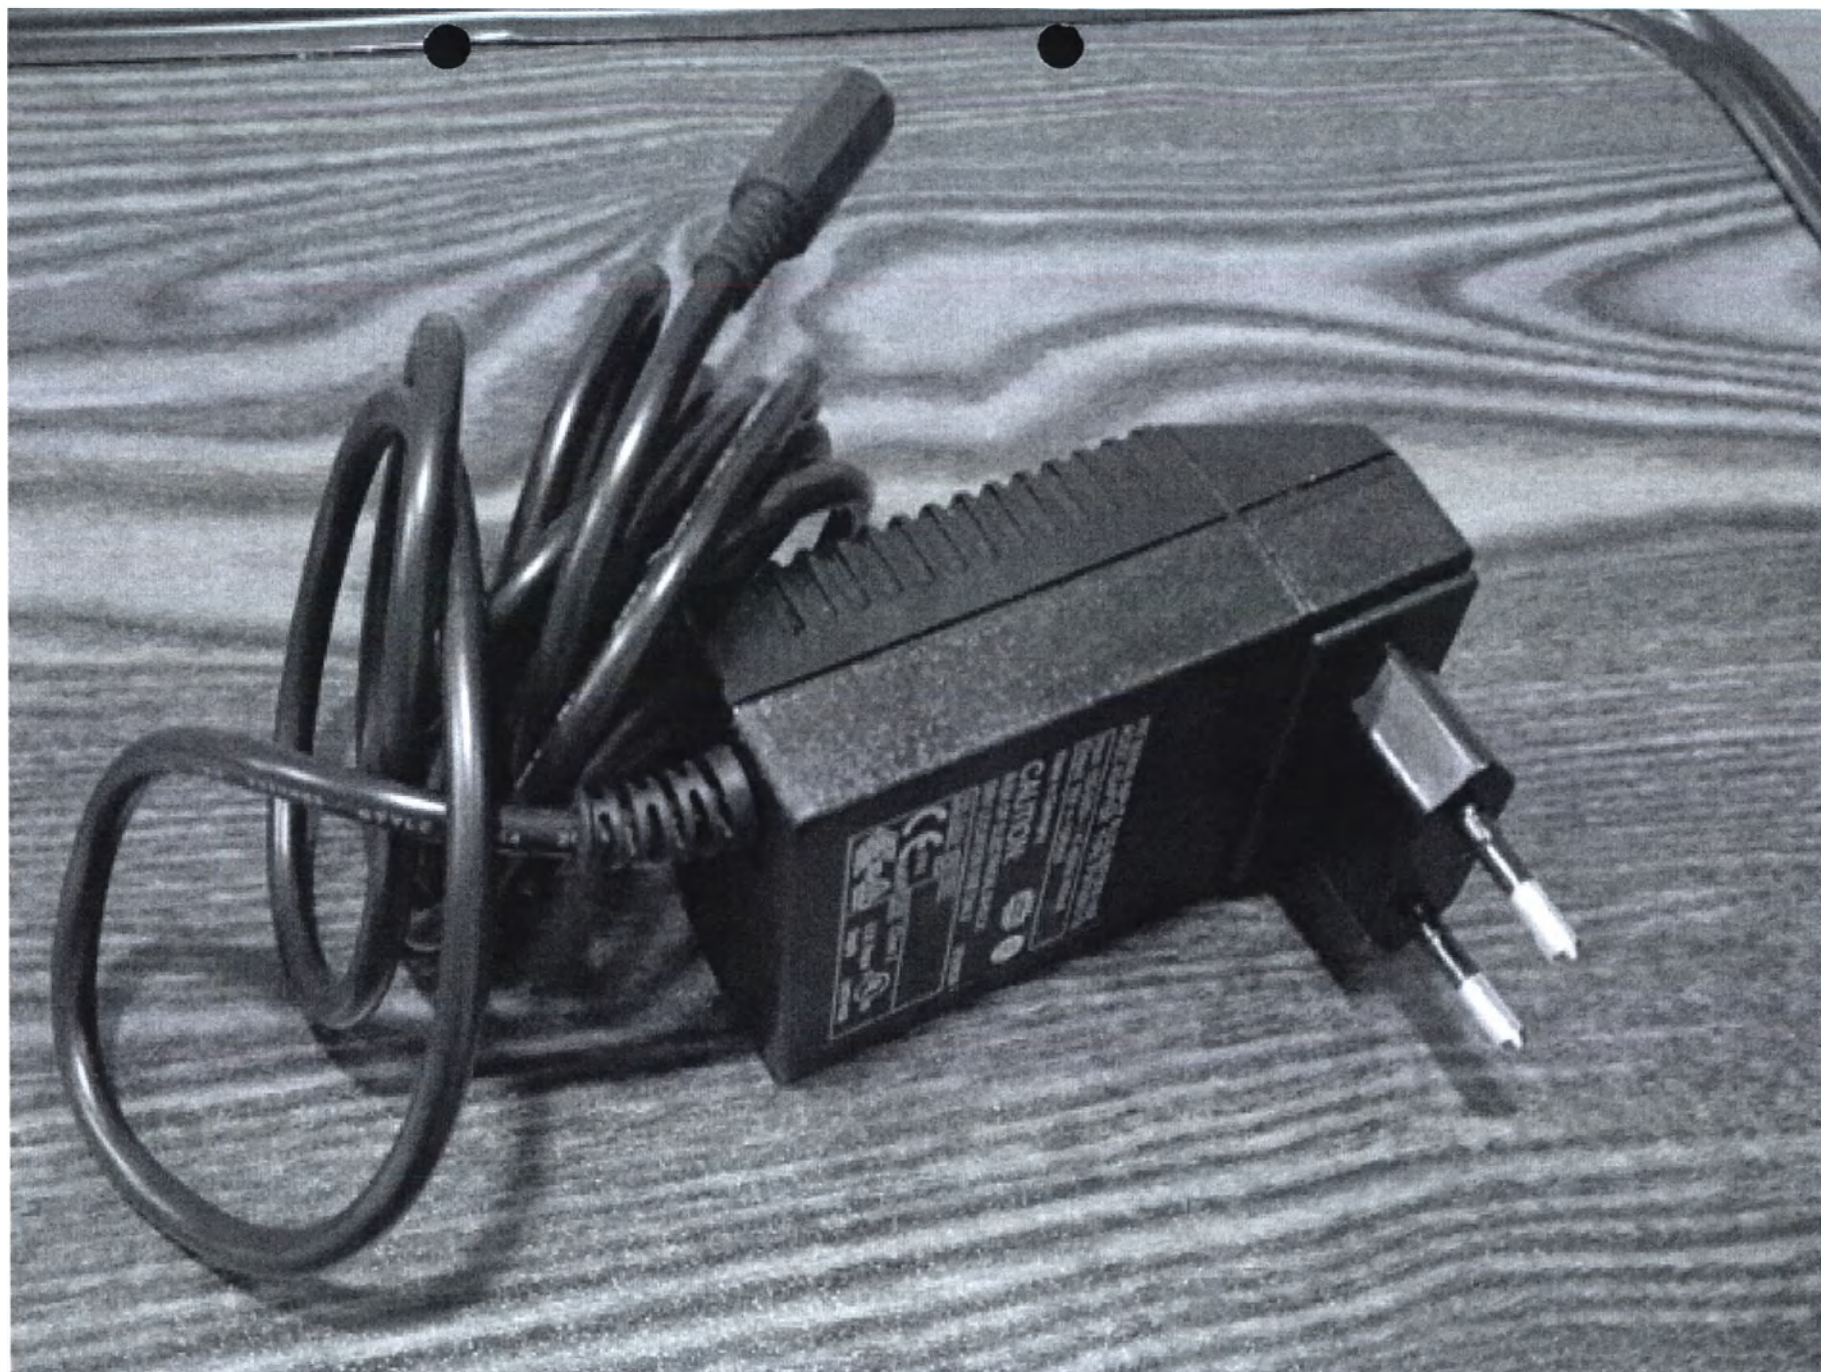

7. Блок питания внешний в сборе (External power supply assembly)

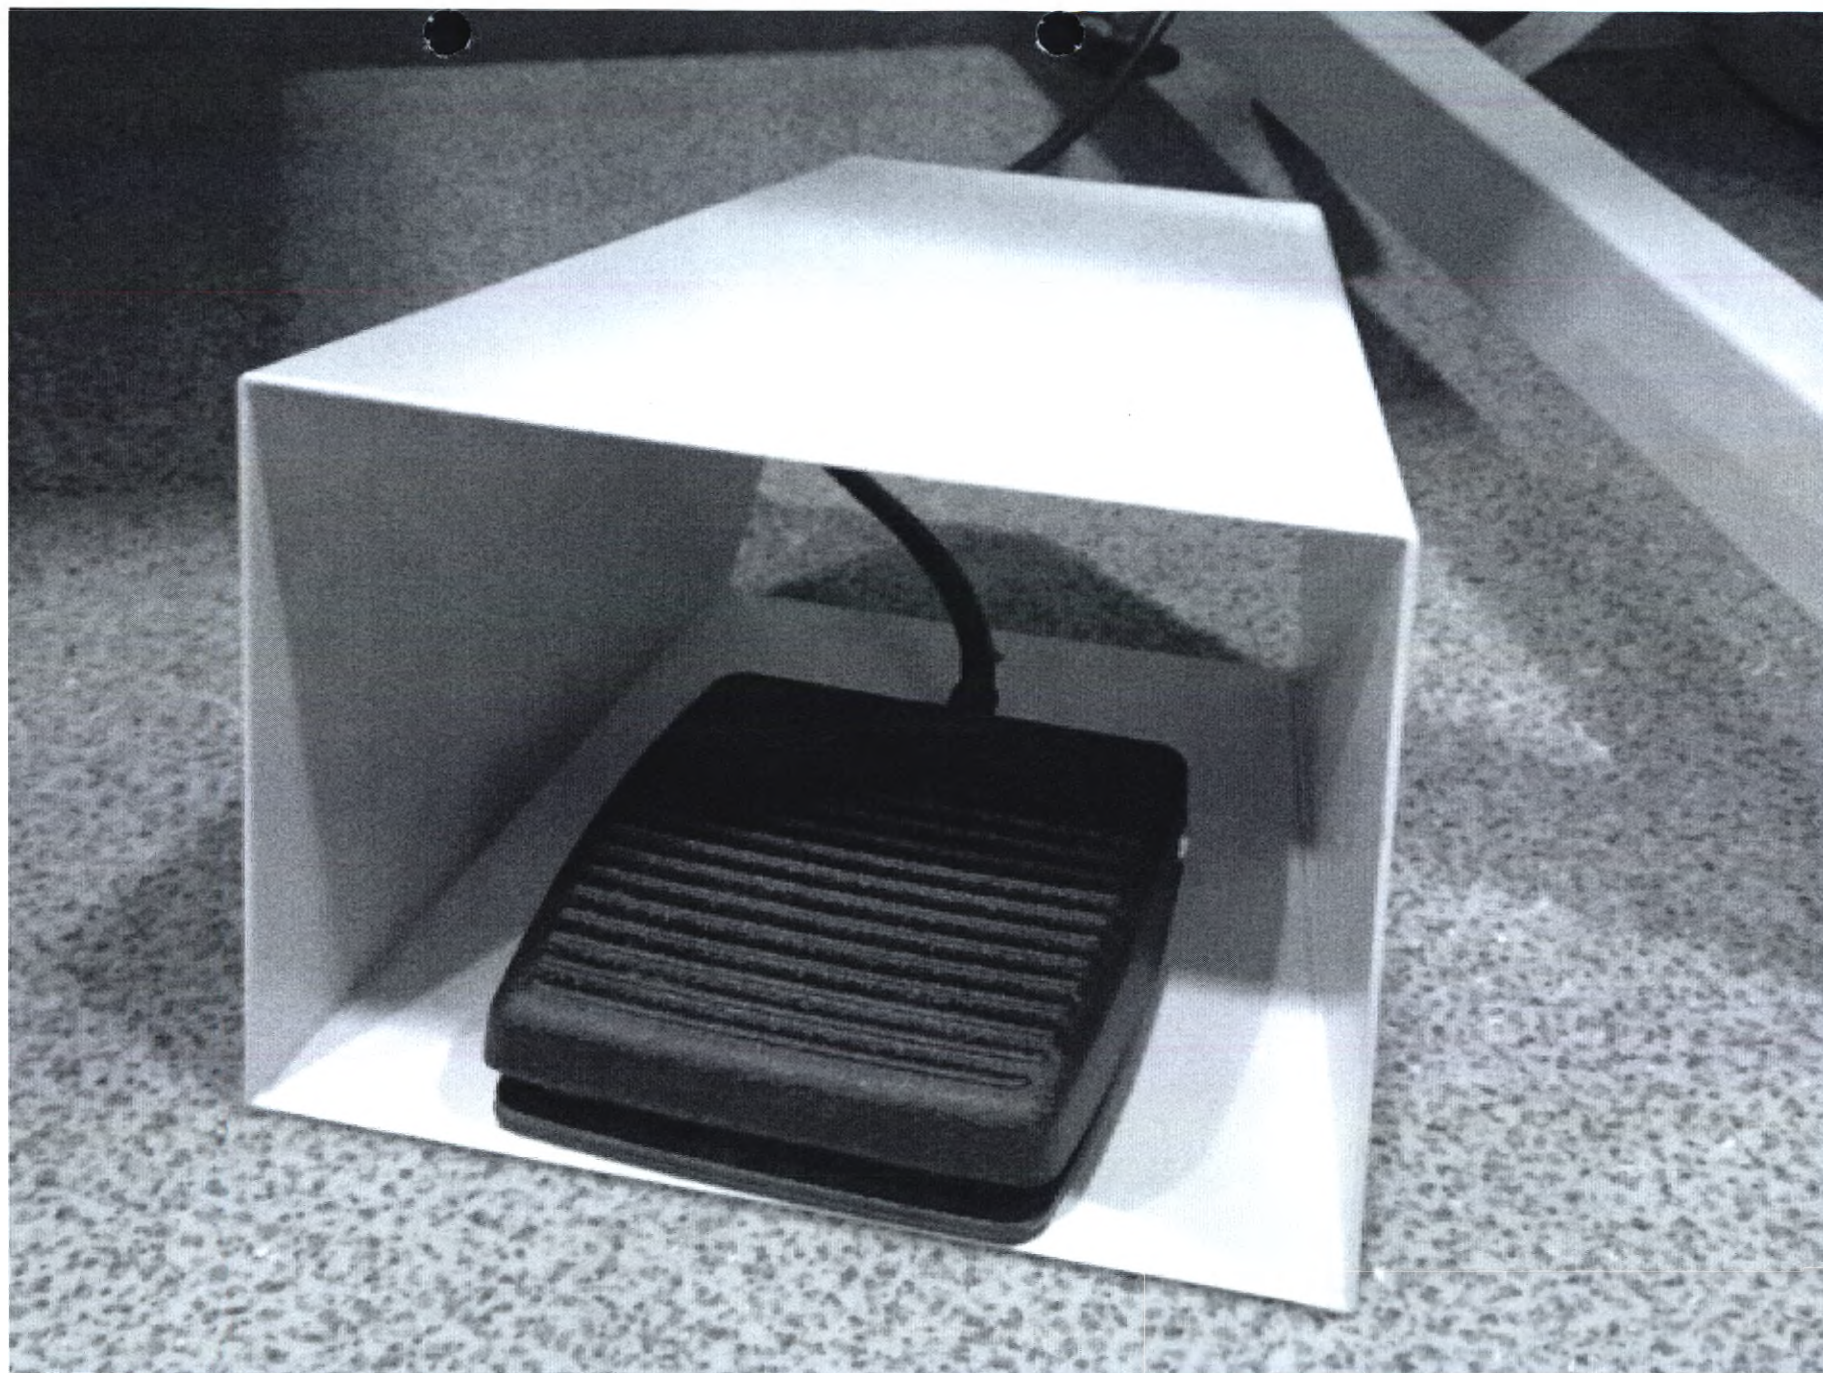

8. Педаль для микротомов ротационных (Foot switch for rotary microtomes)



9. Кисть с магнитом (Brush with magnet)

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 86 (восемьдесят шесть) листов
Генеральный директор
ООО «БиоЛайн»
Семенов А.В.

