

МЕДПОСТАВКА

ООО «МЕДПОСТАВКА»
170100, г. Тверь, Вагжановский переулок, д.9, оф. 311
т. 8(906)552-71-18, ИНН/КПП 6950131108/695001001
medpostavka@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПОСТАВКА»



Гонтарева Н. В.

«20» января 2021 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Анализатор мочи URiSCAN, в вариантах исполнения

2021



Рисунок 1. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: общий вид медицинского изделия.



Рисунок 2. Анализатор мочи URiSCAN-Pro: общий вид






Рисунок 3. Анализатор мочи URiSCAN-Pro: вид сзади

URiSCAN PRO

Urine Chemistry Analyzer

Equipment supply	12[V] = 3.5[A]
AC-DC Adaptor	
Rated INPUT Voltage	~100-240[V] 50/60[Hz]
OUTPUT Voltage	12[V] = 3.5[A]



2019.10.04

S N - UG-91002782



YD Diagnostics

Manufacturer

YD Diagnostics CORP.

76, Seon-ro, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,

Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea

Tel. 82-31-329-2000 / Fax. 82-31-329-2002

EC REP

CARE diagnostica

46562 Voerde, Weseler Str. 110 Germany

TEL : 49-281-94-40-40

FAX : 49-281-944-04-10



WARNING
PLEASE REFER TO
ACCOMPANYING DOCUMENT

REF

YM-027

CE

IVD



MADE IN KOREA

Рисунок 4. Анализатор мочи URiSCAN-Pro: маркировка

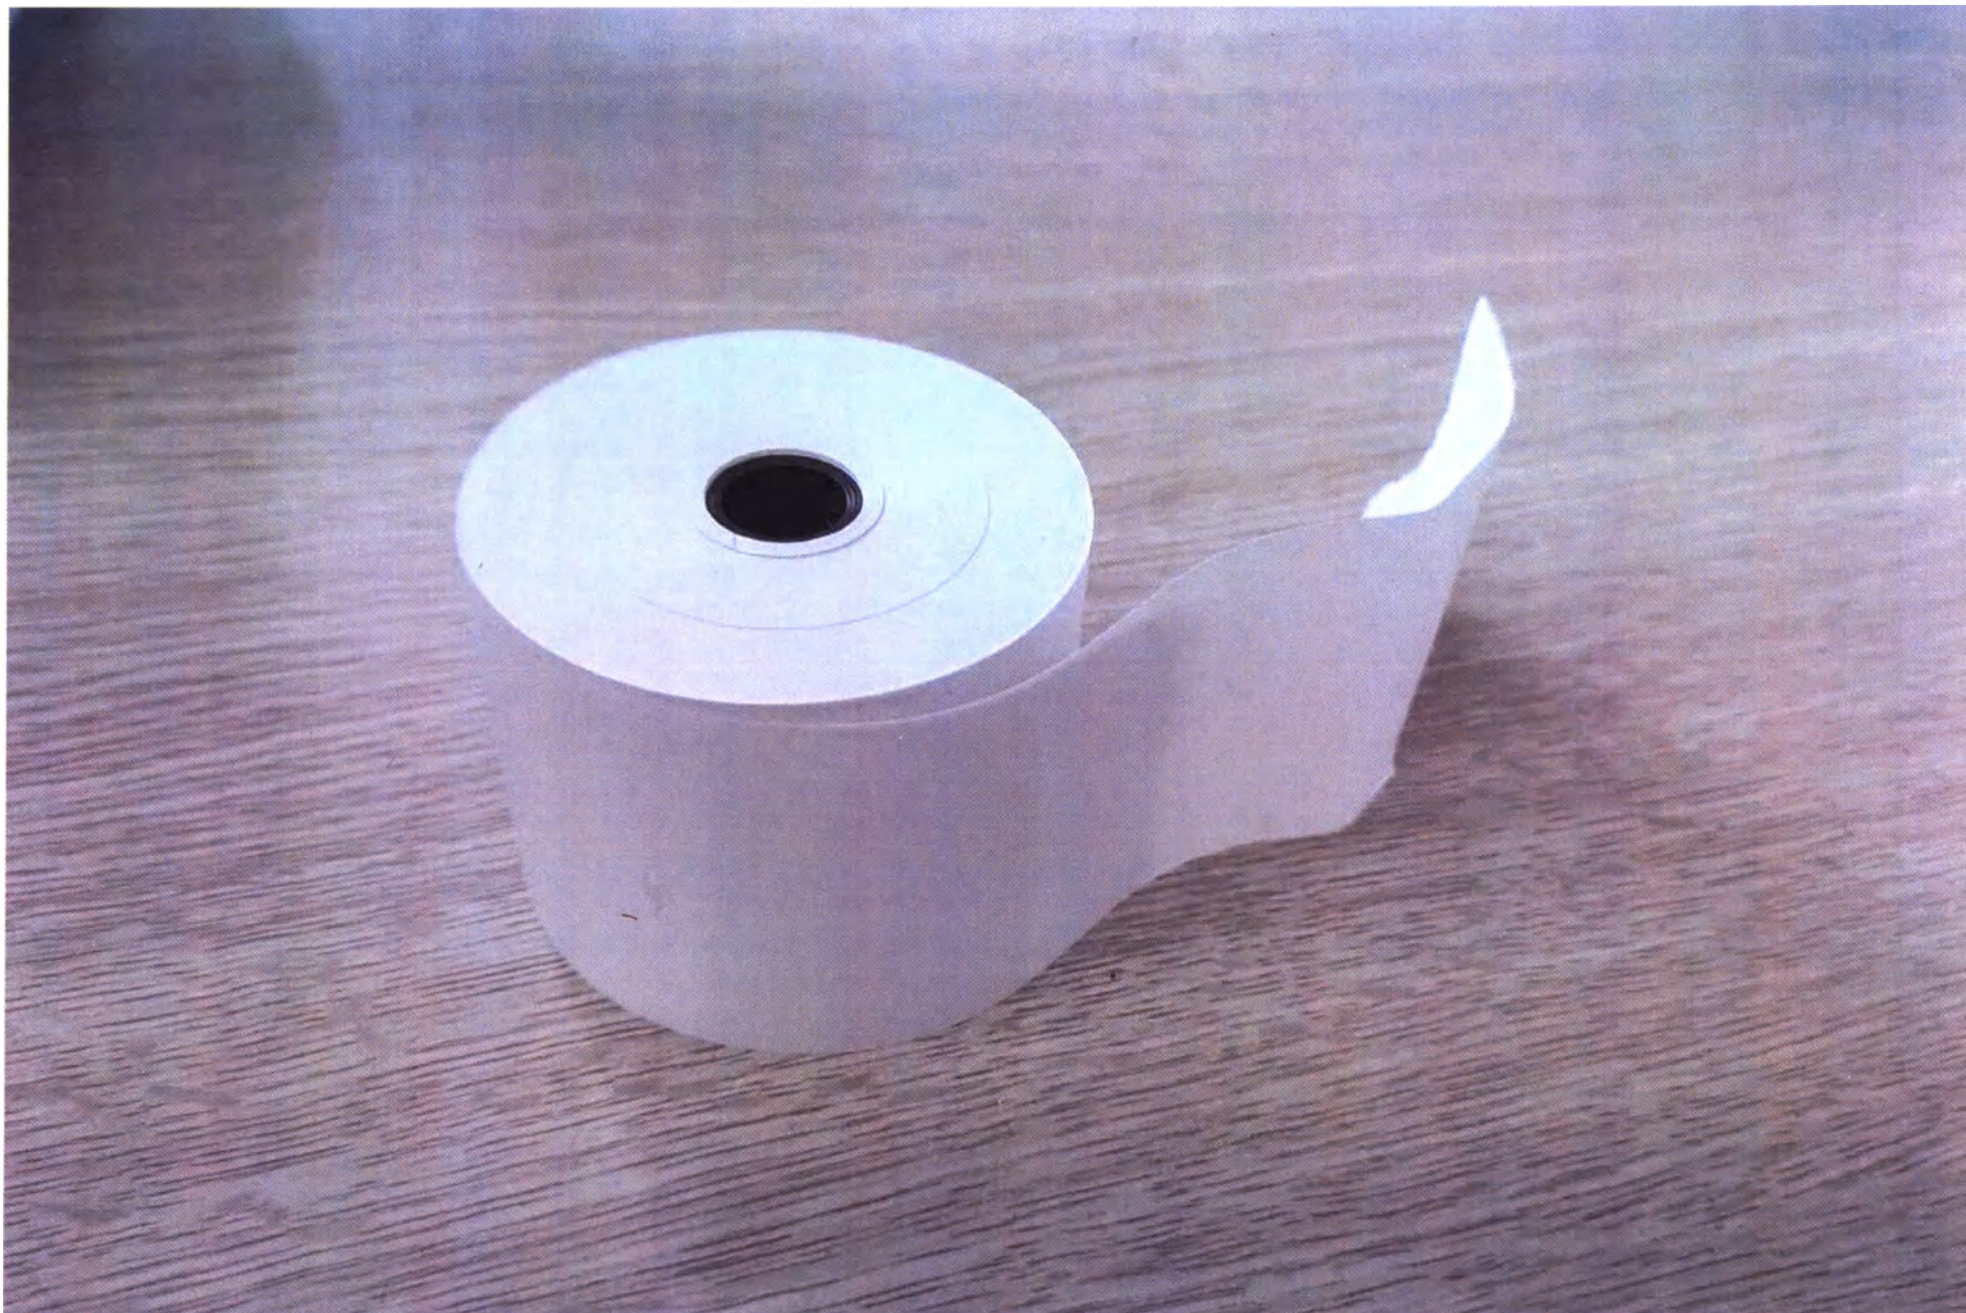


Рисунок 5. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Бумага для термопринтера



Рисунок 6. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Кабель электропитания, 3 м



Рисунок 7. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Сетевой адаптер питания



Рисунок 8. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Направляющая пластина для полосок



Рисунок 9. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Толкатель полосок



Рисунок 10. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Проверочные полоски для калибровки 1 тубус: общий вид упаковки

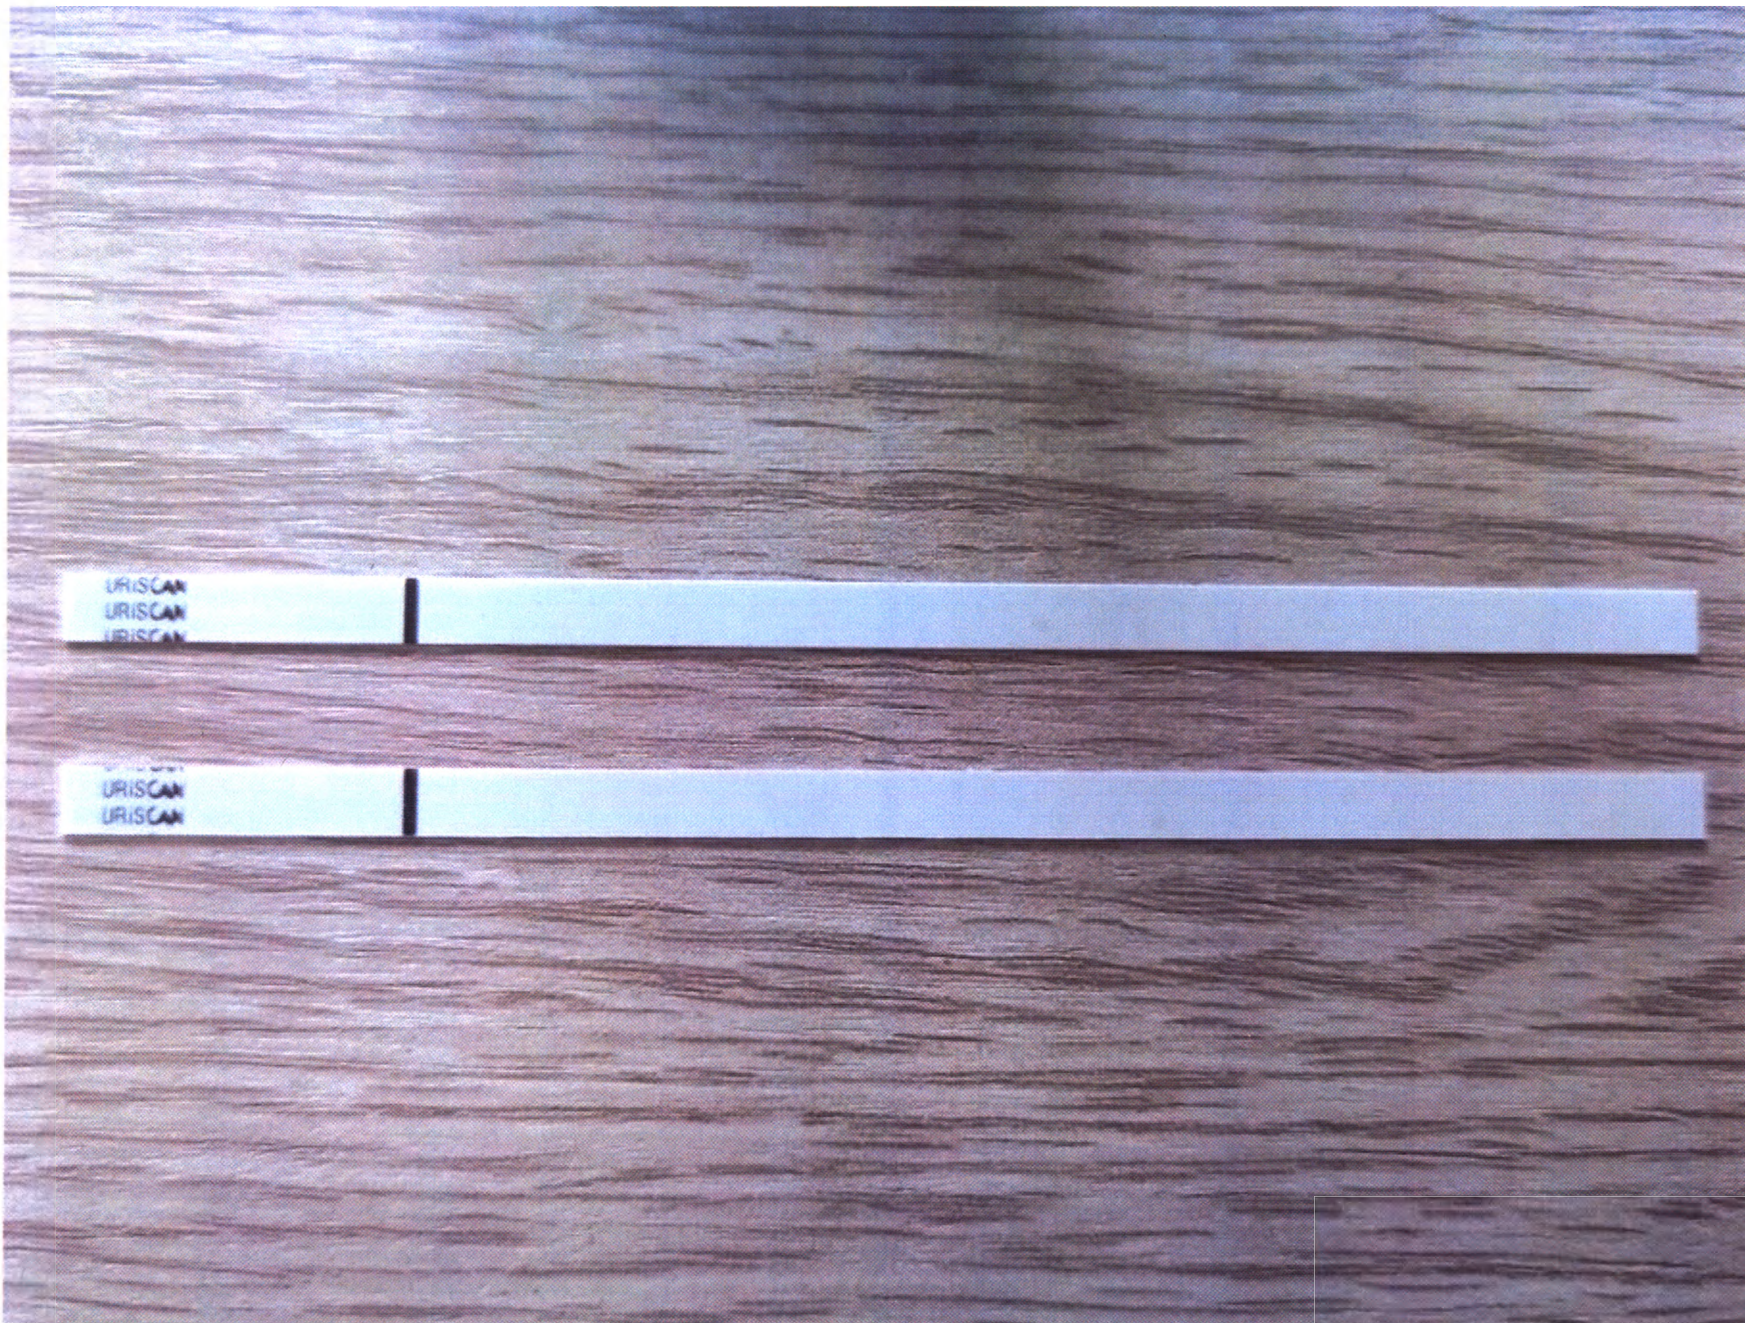


Рисунок 11. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Проверочные полоски для калибровки 1 тубус: общий вид полоски

YD Diagnostic HGH., Republic of Korea
YD Diagnostic GmbH., Republic of Korea

YD Diagnostic

Анализатор мочи URiSCAN

МОДЕЛЬ

URiSCAN-PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выпуск в обращение



2019

Рисунок 12. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Руководство по эксплуатации



Рисунок 13. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Кабель для передачи данных в формате последовательного соединения RS 232C, 3 м



Рисунок 14. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: Сканер штрих-кода



Рисунок 15. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro: общий вид транспортной упаковки



Рисунок 16. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: общий вид медицинского изделия



Рисунок 17. Анализатор мочи URISCAN-Optima: общий вид



Рисунок 18. Анализатор мочи URiSCAN-Optima: вид сзади

URiSCAN optima

SEMI-AUTO Urine Analyzer



WARNING

PLEASE REFER TO
ACCOMPANYING DOCUMENT.

Equipment supply	12[V] $\approx$ 3.5[A]
AC-DC Adaptor	
Rated INPUT Voltage	-100-240[V] 50/60[Hz]
OUTPUT Voltage	12[V] $\approx$ 3.5[A]



2019.10.14

SN- UD-91013872



YD Diagnostics



Manufacturer

YD Diagnostics CORP.

76, Seori-ro, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yangju-si,
Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea
Tel. 82-31-329-2000 / Fax. 82-31-329-2002

EC REP

CARE diagnostica

46562 Voerde, Weseler Str. 110 Germany

TEL : 49-281-94-40-40

FAX : 49-281-944-04-10

MADE IN KOREA

Рисунок 19. Анализатор мочи URiSCAN-Optima : маркировка



Рисунок 20. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: Бумага для термопринтера

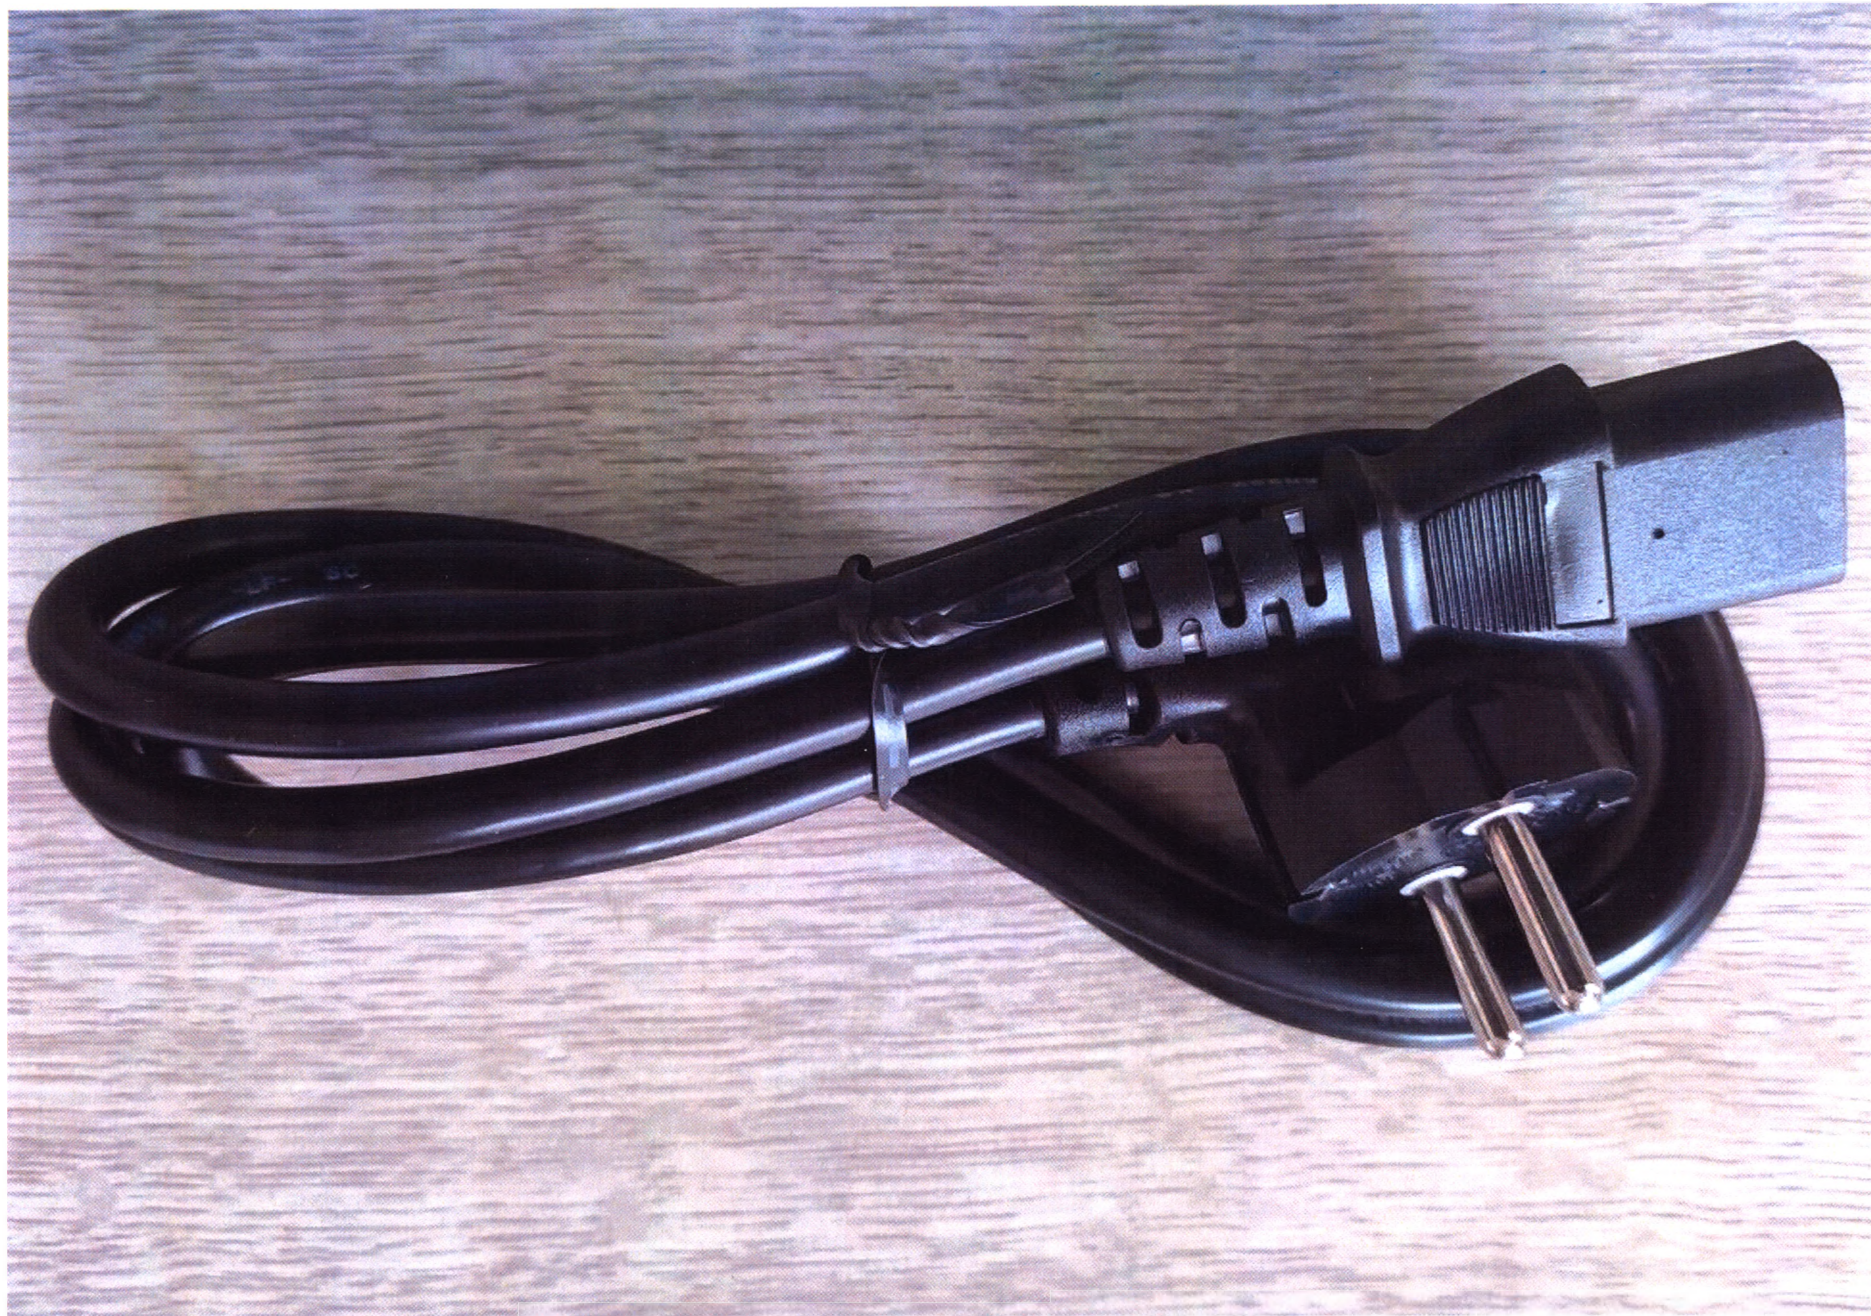


Рисунок 21. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: Кабель электропитания, 3 м



Рисунок 22. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: Сетевой адаптер питания

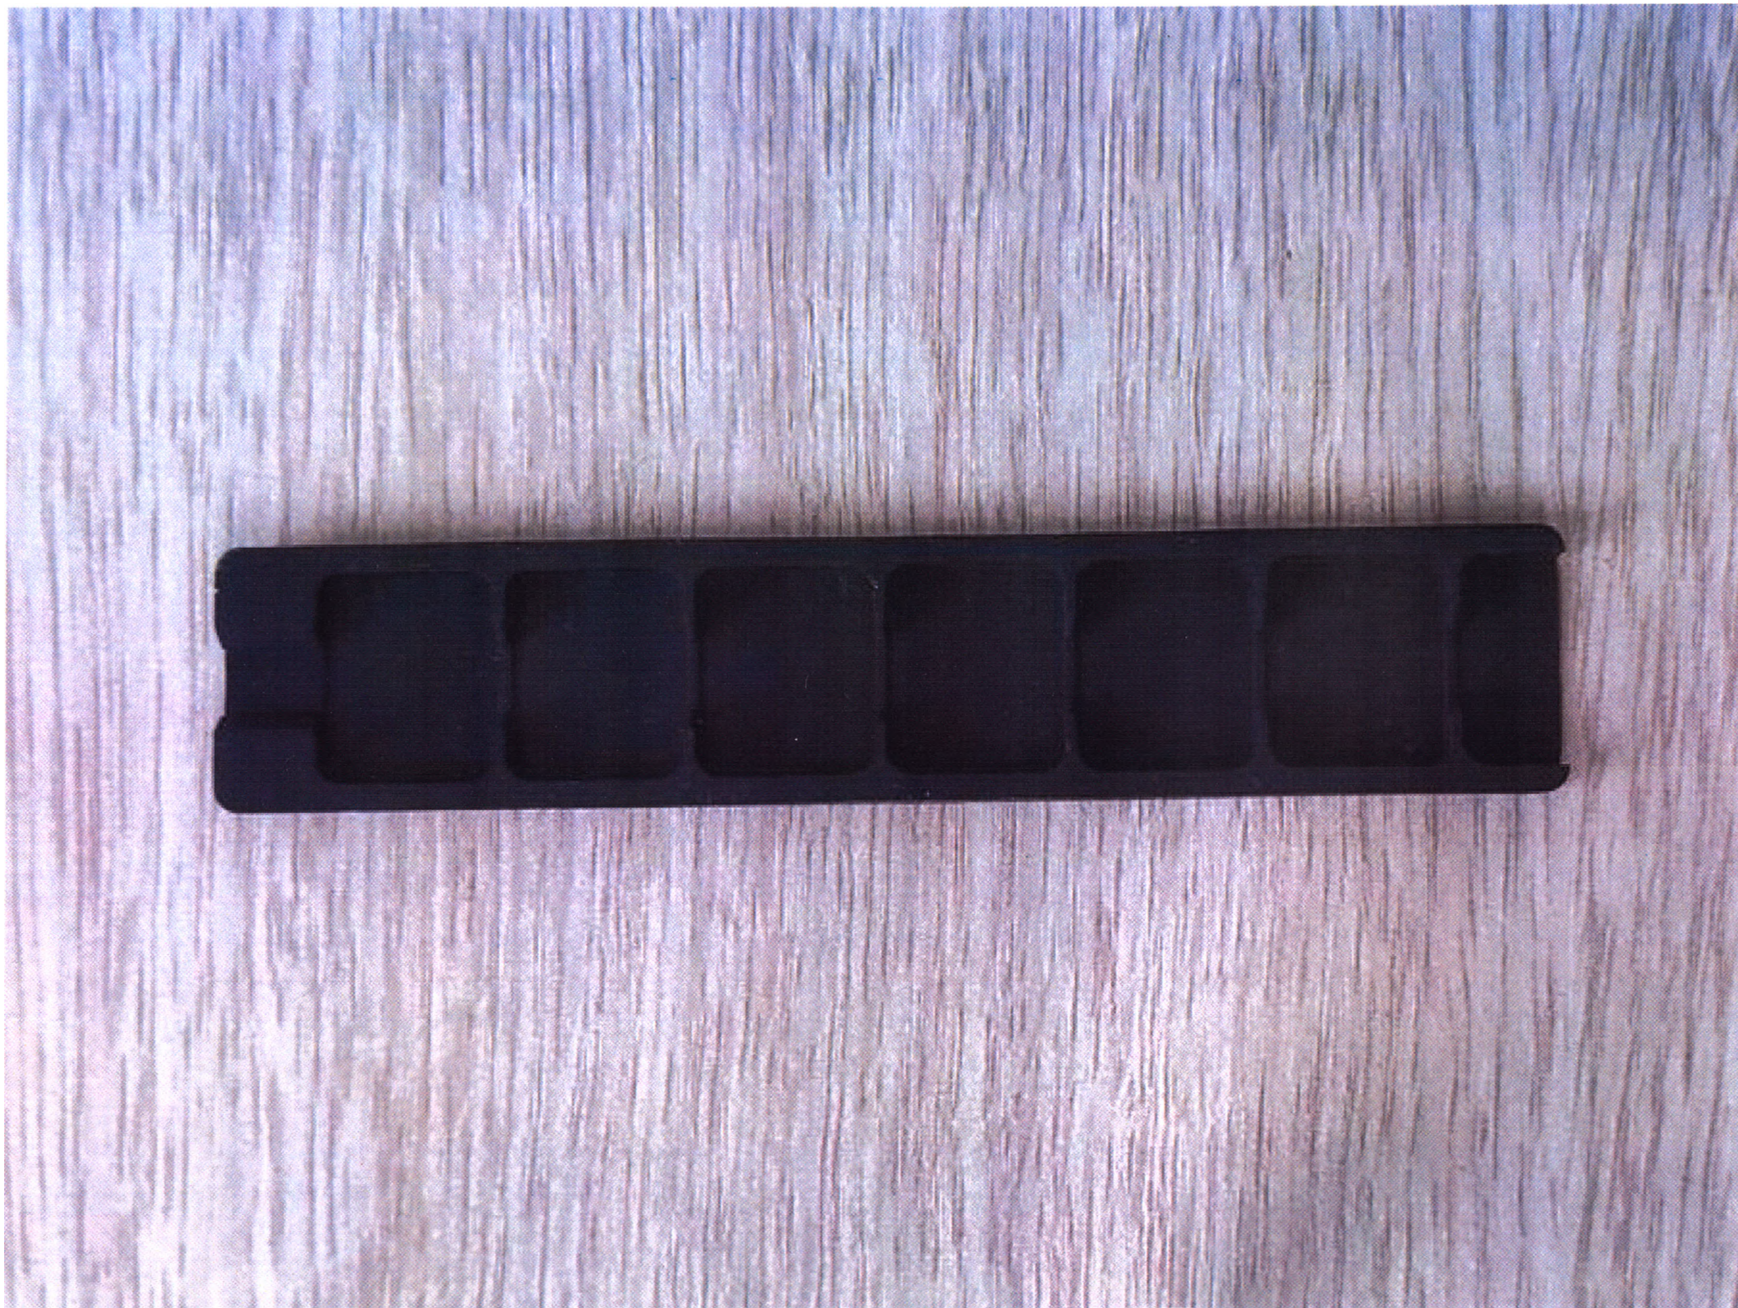


Рисунок 23. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: Держатель полоски



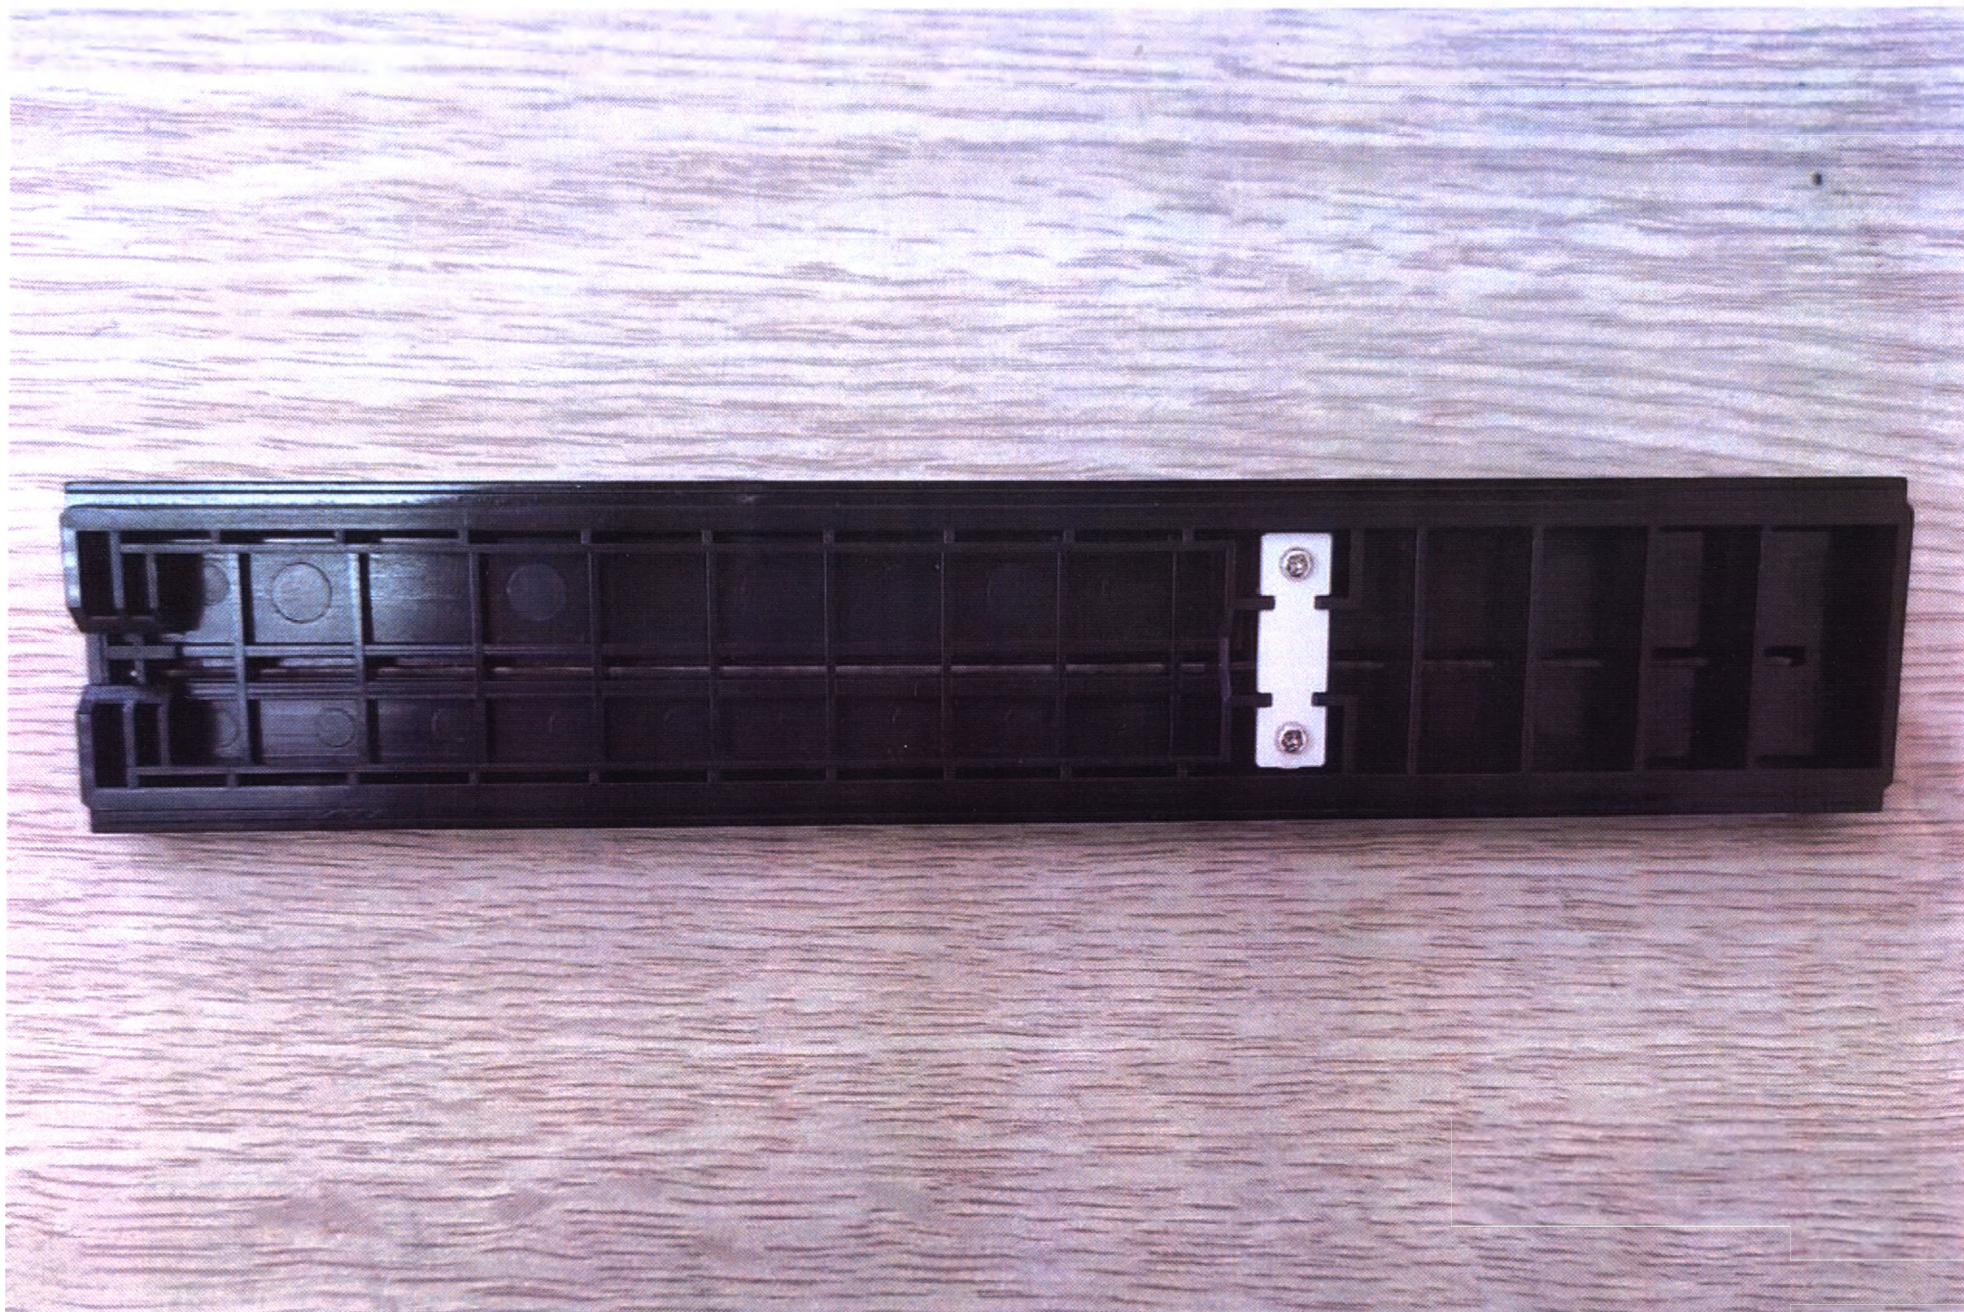


Рисунок 24. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: Толкатель полосок



Рисунок 25. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: Проверочные полоски для калибровки 1 тубус

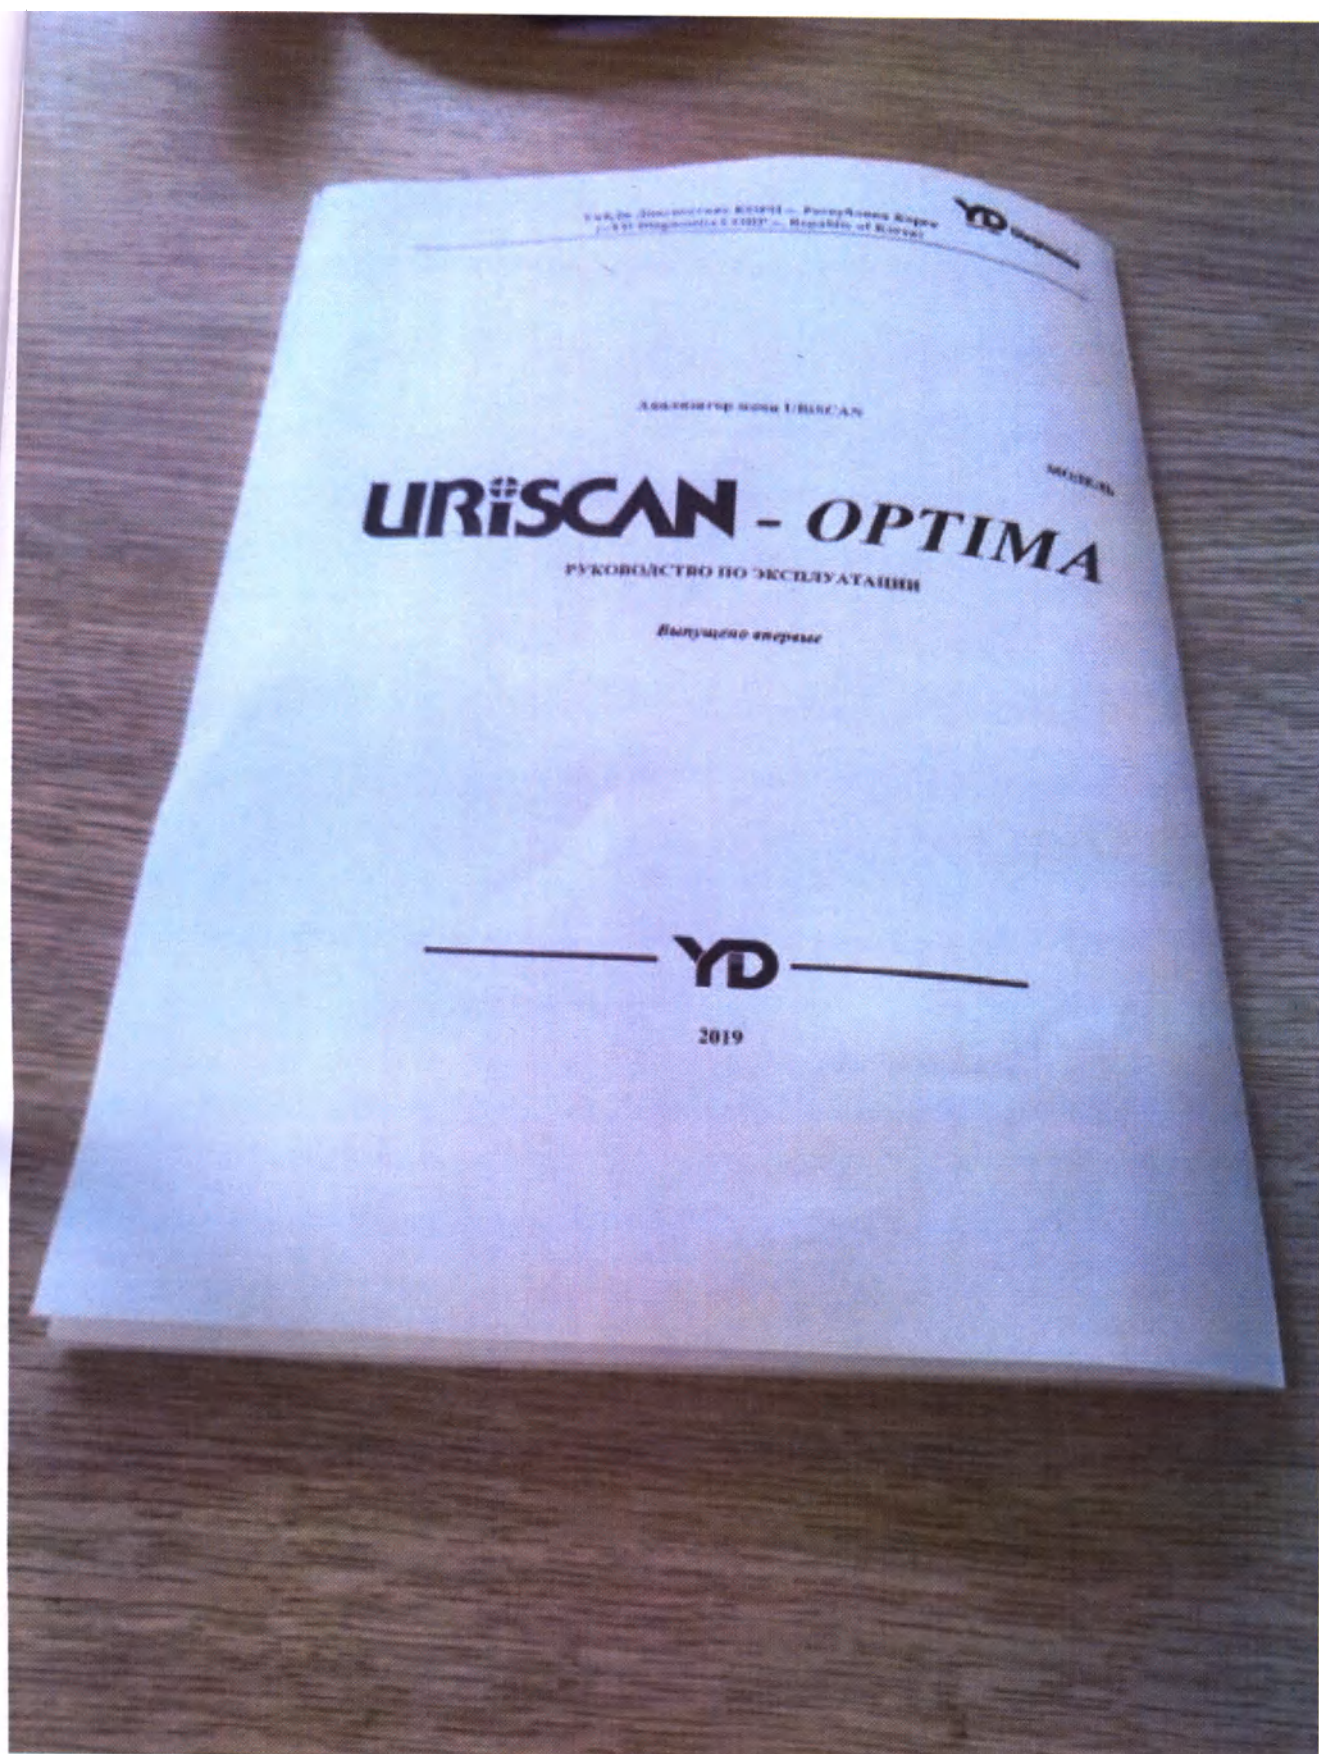


Рисунок 26. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: Руководство по эксплуатации



Рисунок 27. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: Кабель для передачи данных в формате последовательного соединения RS 232C, 3 м



Рисунок 28. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima: Сканер штрих-кода

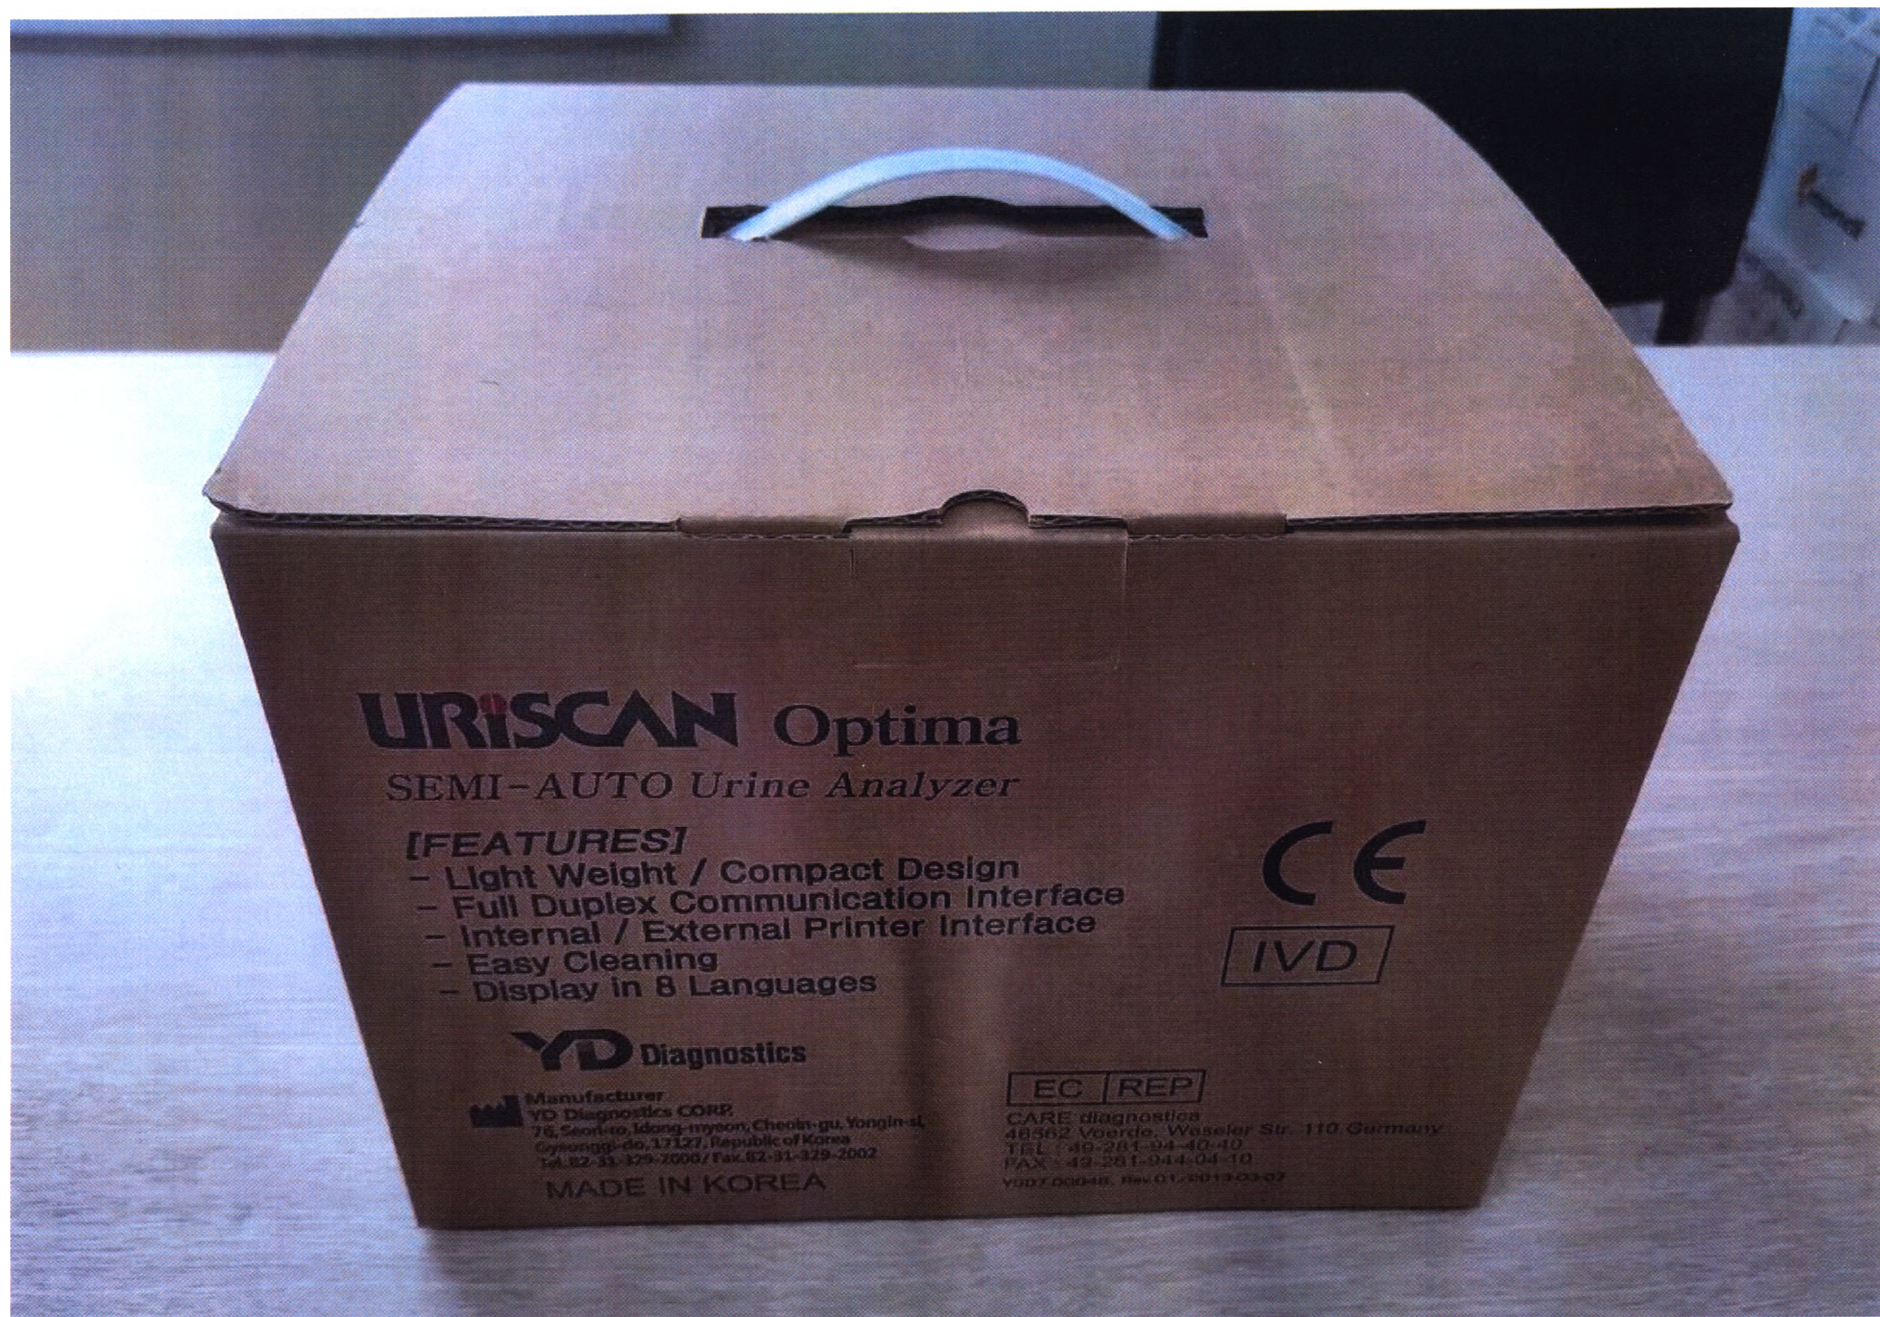


Рисунок 29. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Оптим: общий вид транспортной упаковки



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 30 (Тридцать) листов (-а)

Генеральный директор
ООО «МЕДПОСТАВКА»

Гонтарева Н.В. 

