



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2021/15101

На медицинское изделие
Анализатор мочи URiSCAN

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"УайДи Диагностикс КОРП.", Республика Корея,
YD Diagnostics CORP., 76, Seori-ro, Idong-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
17127, Republic of Korea

Производитель
"УайДи Диагностикс КОРП.", Республика Корея,
YD Diagnostics CORP., 76, Seori-ro, Idong-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
17127, Republic of Korea

Место производства медицинского изделия
YD Diagnostics CORP., 76, Seori-ro, Idong-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
17127, Republic of Korea


Номер регистрационного досье № РД-53134/77426 от 23.11.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.51.53.141

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 ноября 2022 года № 11267
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

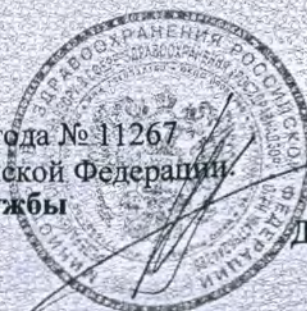

Д.Ю. Павлюков

0067243

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года

№ РЗН 2021/15101

Лист 1

На медицинское изделие

Анализатор мочи URiSCAN, в вариантах исполнения:

I. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Pro, в составе:

1. Анализатор мочи URiSCAN-Pro - 1 шт.
2. Бумага для термопринтера - не более 2 шт. (при необходимости).
3. Кабель электропитания, 3 м - 1 шт.
4. Сетевой адаптер питания - 1 шт.
5. Направляющая пластина для полосок - не более 2 шт. (при необходимости).
6. Толкатель полосок - не более 2 шт. (при необходимости).
7. Проверочные полоски для калибровки 1 тубус - не более 2 шт. (при необходимости).
8. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
9. Кабель для передачи данных в формате последовательного соединения RS 232C, 3 м - 1 шт. (при необходимости).
10. Сканер штрих-кода - 1 шт. (при необходимости).

II. Анализатор мочи URiSCAN, модель URiSCAN-Optima, в составе:

1. Анализатор мочи URiSCAN-Optima - 1 шт.
2. Бумага для термопринтера - не более 2 шт. (при необходимости).
3. Кабель электропитания, 3 м - 1 шт.
4. Сетевой адаптер питания - 1 шт.
5. Держатель полоски - не более 2 шт. (при необходимости).
6. Толкатель полосок - не более 2 шт. (при необходимости).
7. Проверочные полоски для калибровки 1 тубус - не более 2 шт. (при необходимости).
8. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
9. Кабель для передачи данных в формате последовательного соединения RS 232C, 3 м - 1 шт. (при необходимости).
10. Сканер штрих-кода - 1 шт. (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0112667