

Общество с ограниченной ответственностью «АДАНИ РУС»
190005, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.118А, лит. X, помещение 7-Н, офис 7
ИНН 7839089877, КПП 783901001, ОГРН 1177847274065
Тел. +7 812 389 23 88 E-mail: rus-info@advin.ru

**Фотографические изображения
медицинского изделия**


Аппарат рентгенодиагностический "УНИЭКСПЕРТ"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор



В.О. Скачков

I. Аппарат рентгенодиагностический "УНИЭКСПЕРТ" в следующих исполнениях: "УНИЭКСПЕРТ"; "УНИЭКСПЕРТ 2 плюс"; "УНИЭКСПЕРТ 3 плюс":


I. Состав «УНИЭКСПЕРТ»:

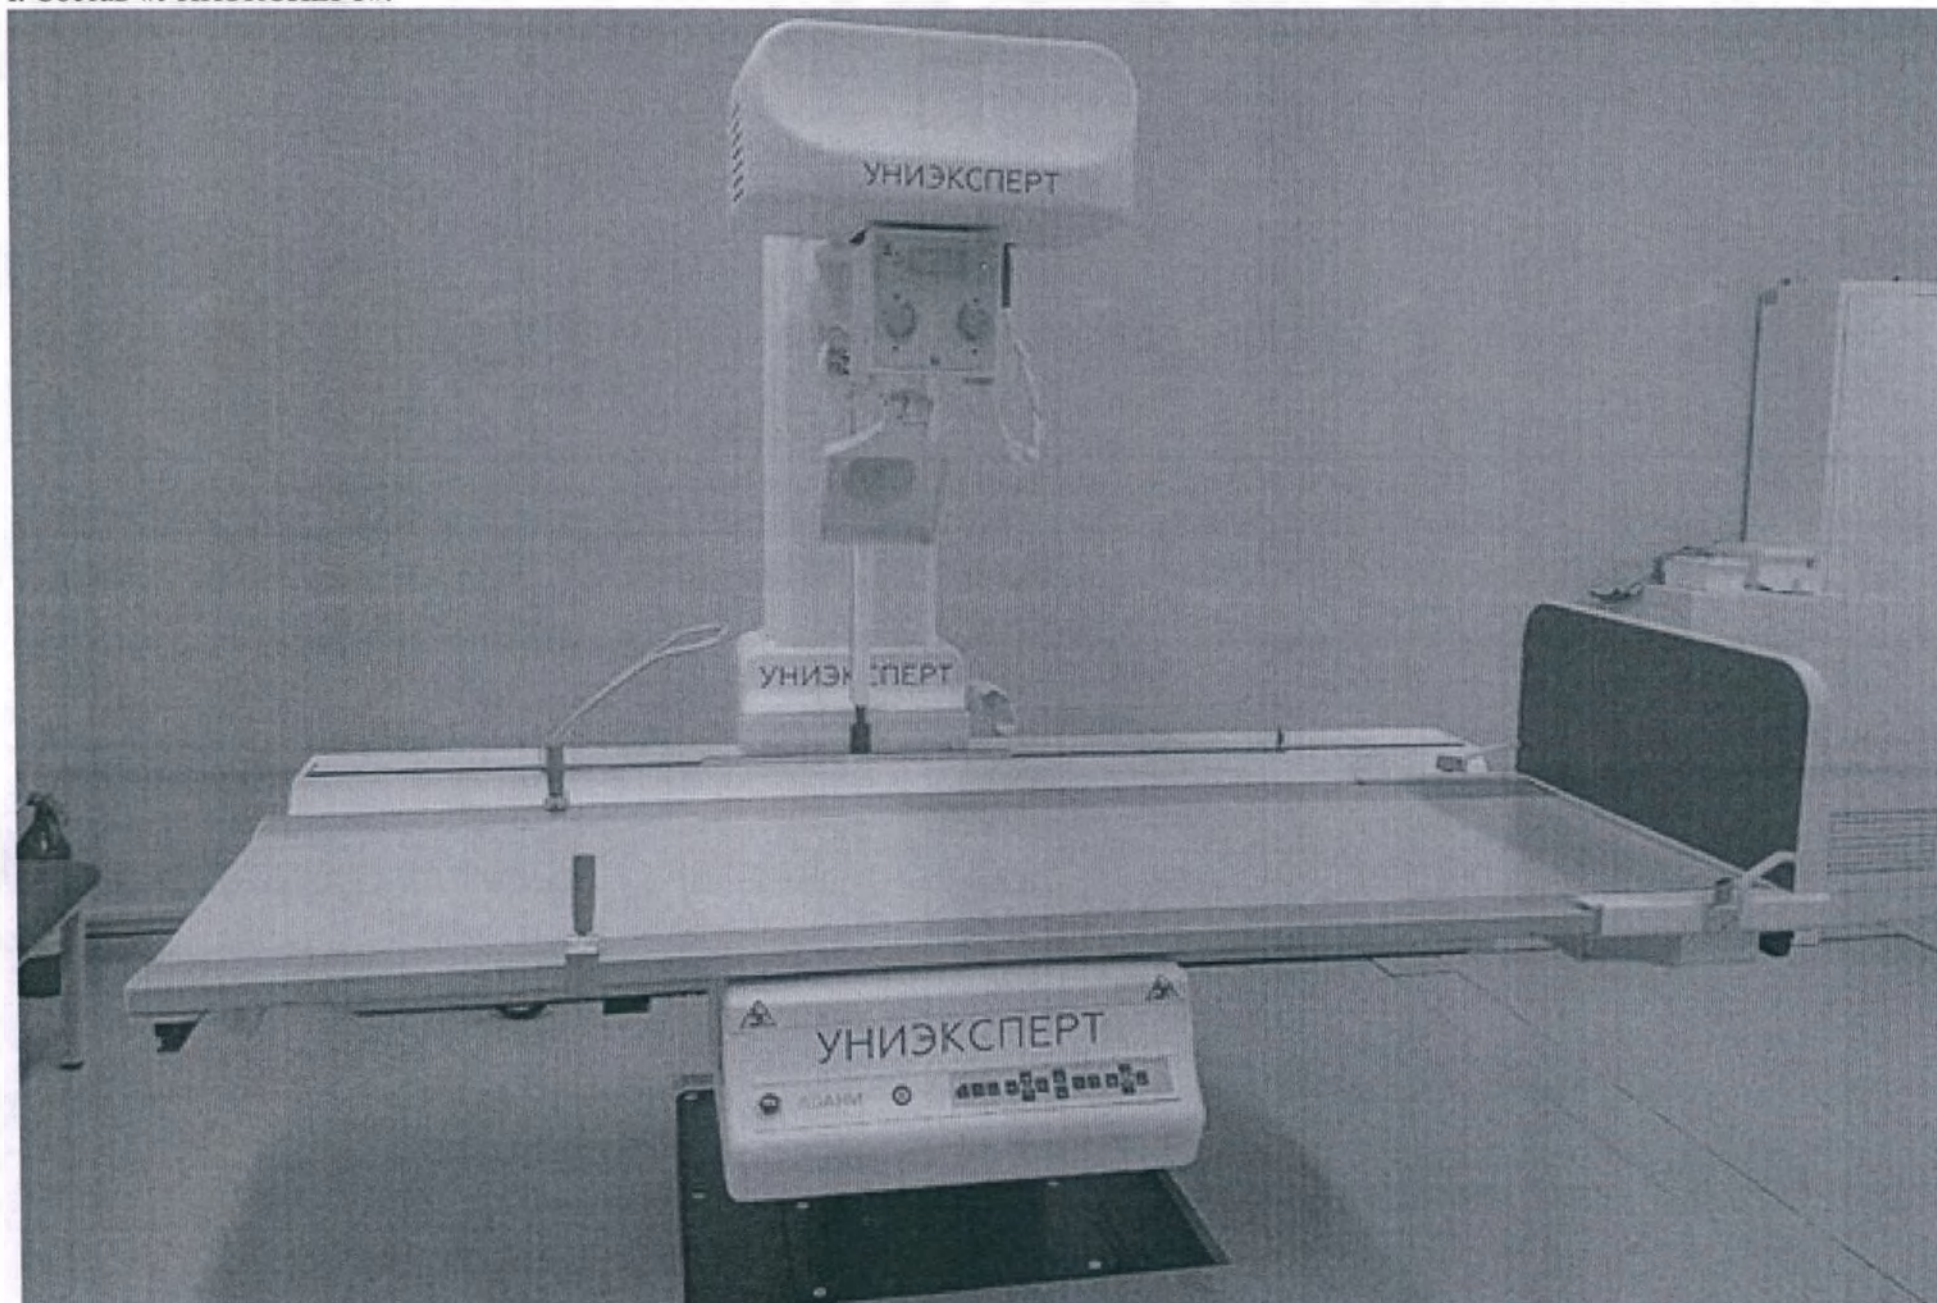


1. Устройство питающее рентгеновское, высокочастотное SHF, HF; SHFR производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания (РУ № ФСЗ 2009/04840);

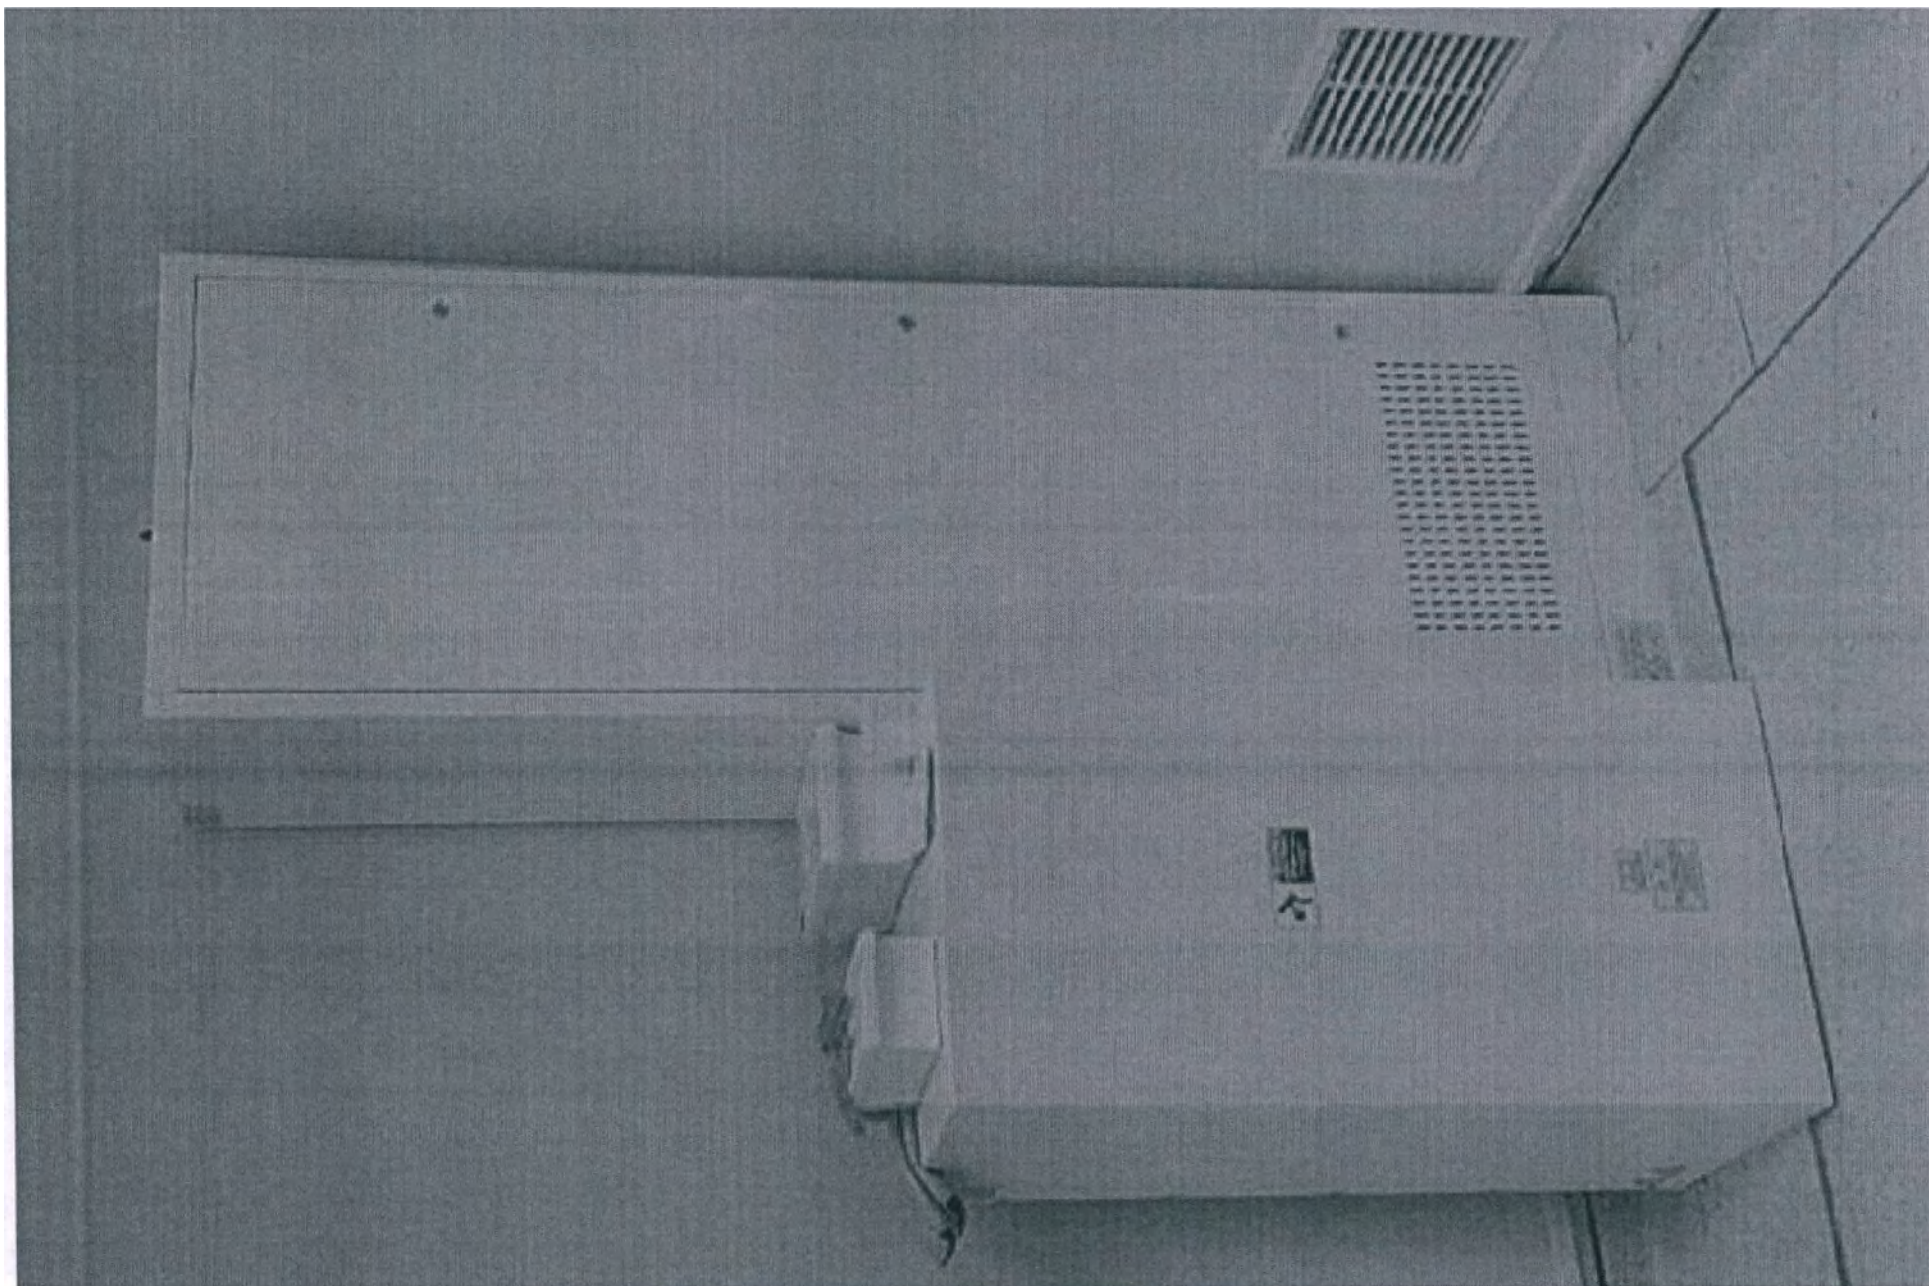

или EPS, EPS EVO производства EMD Technologies LLC, Канада;

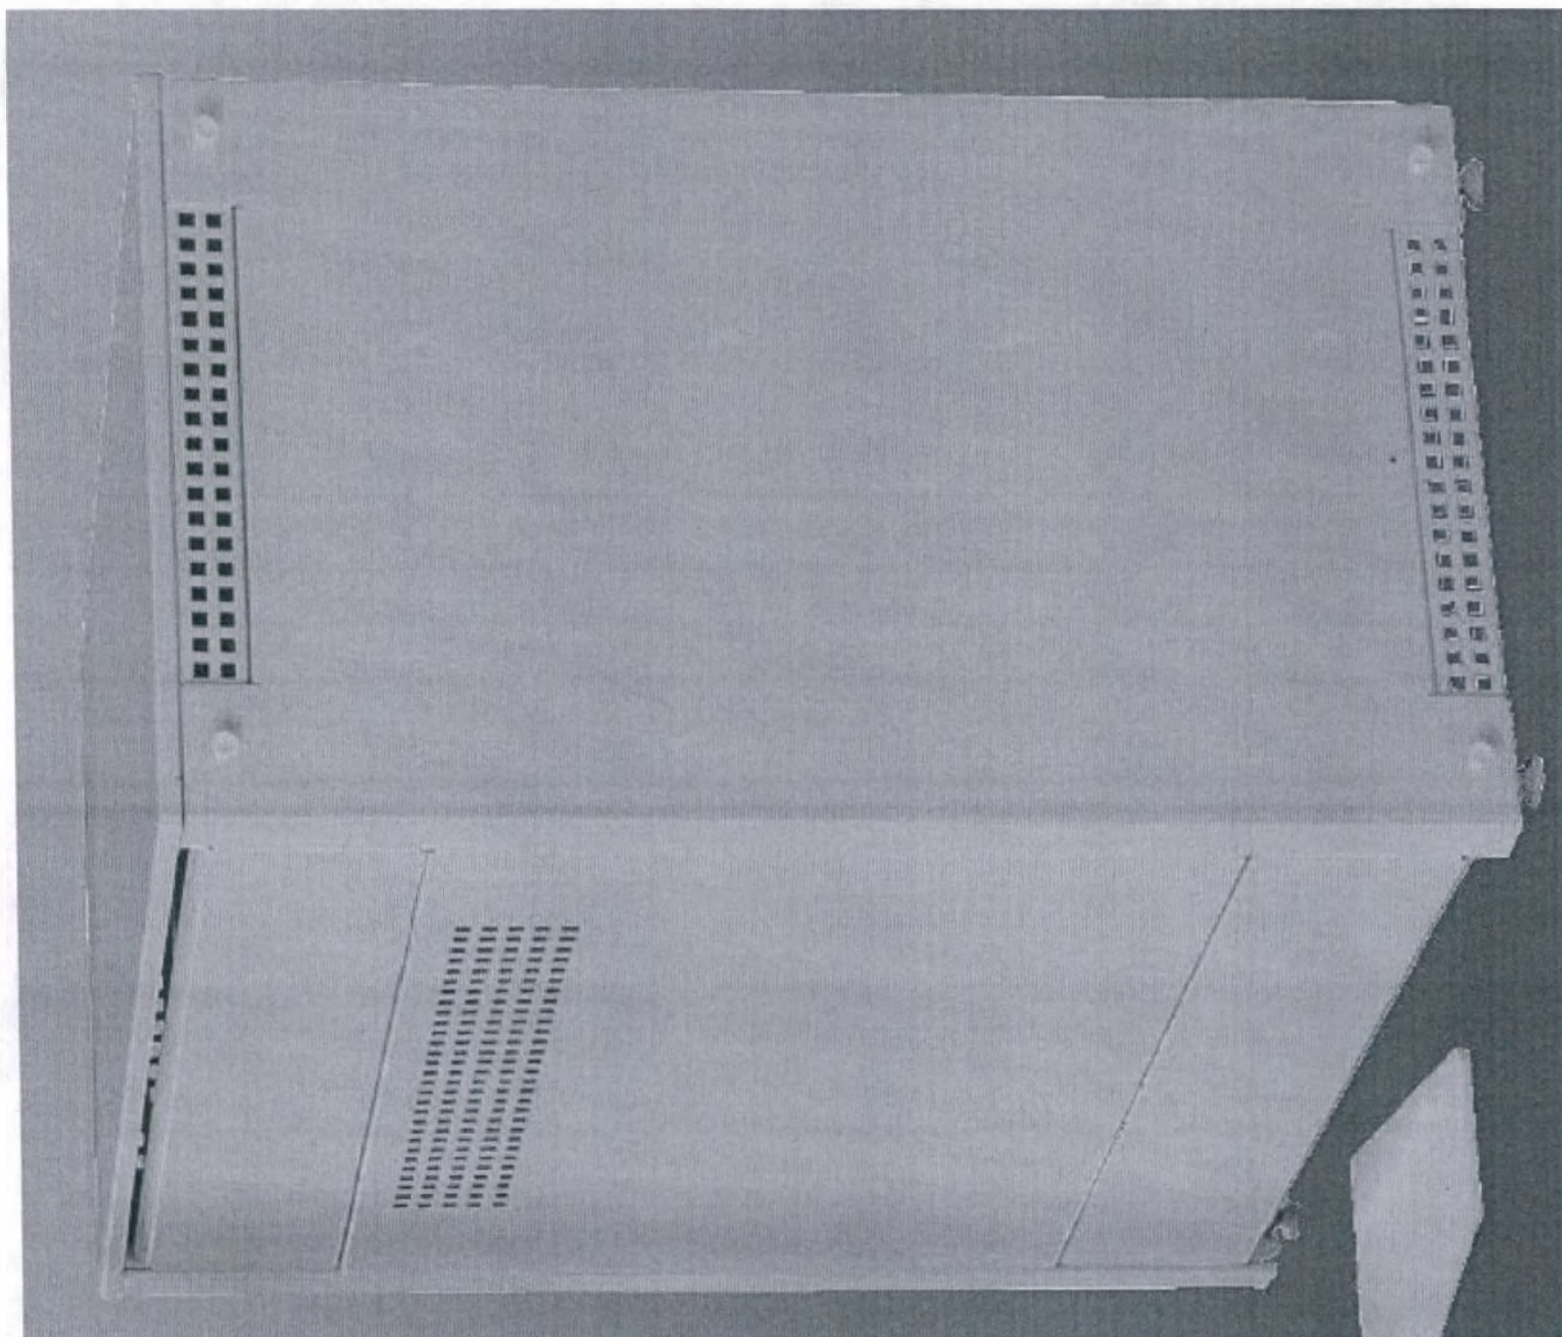


или Indico, CMP производства Communications & Power Industries Canada, Inc., Канада;

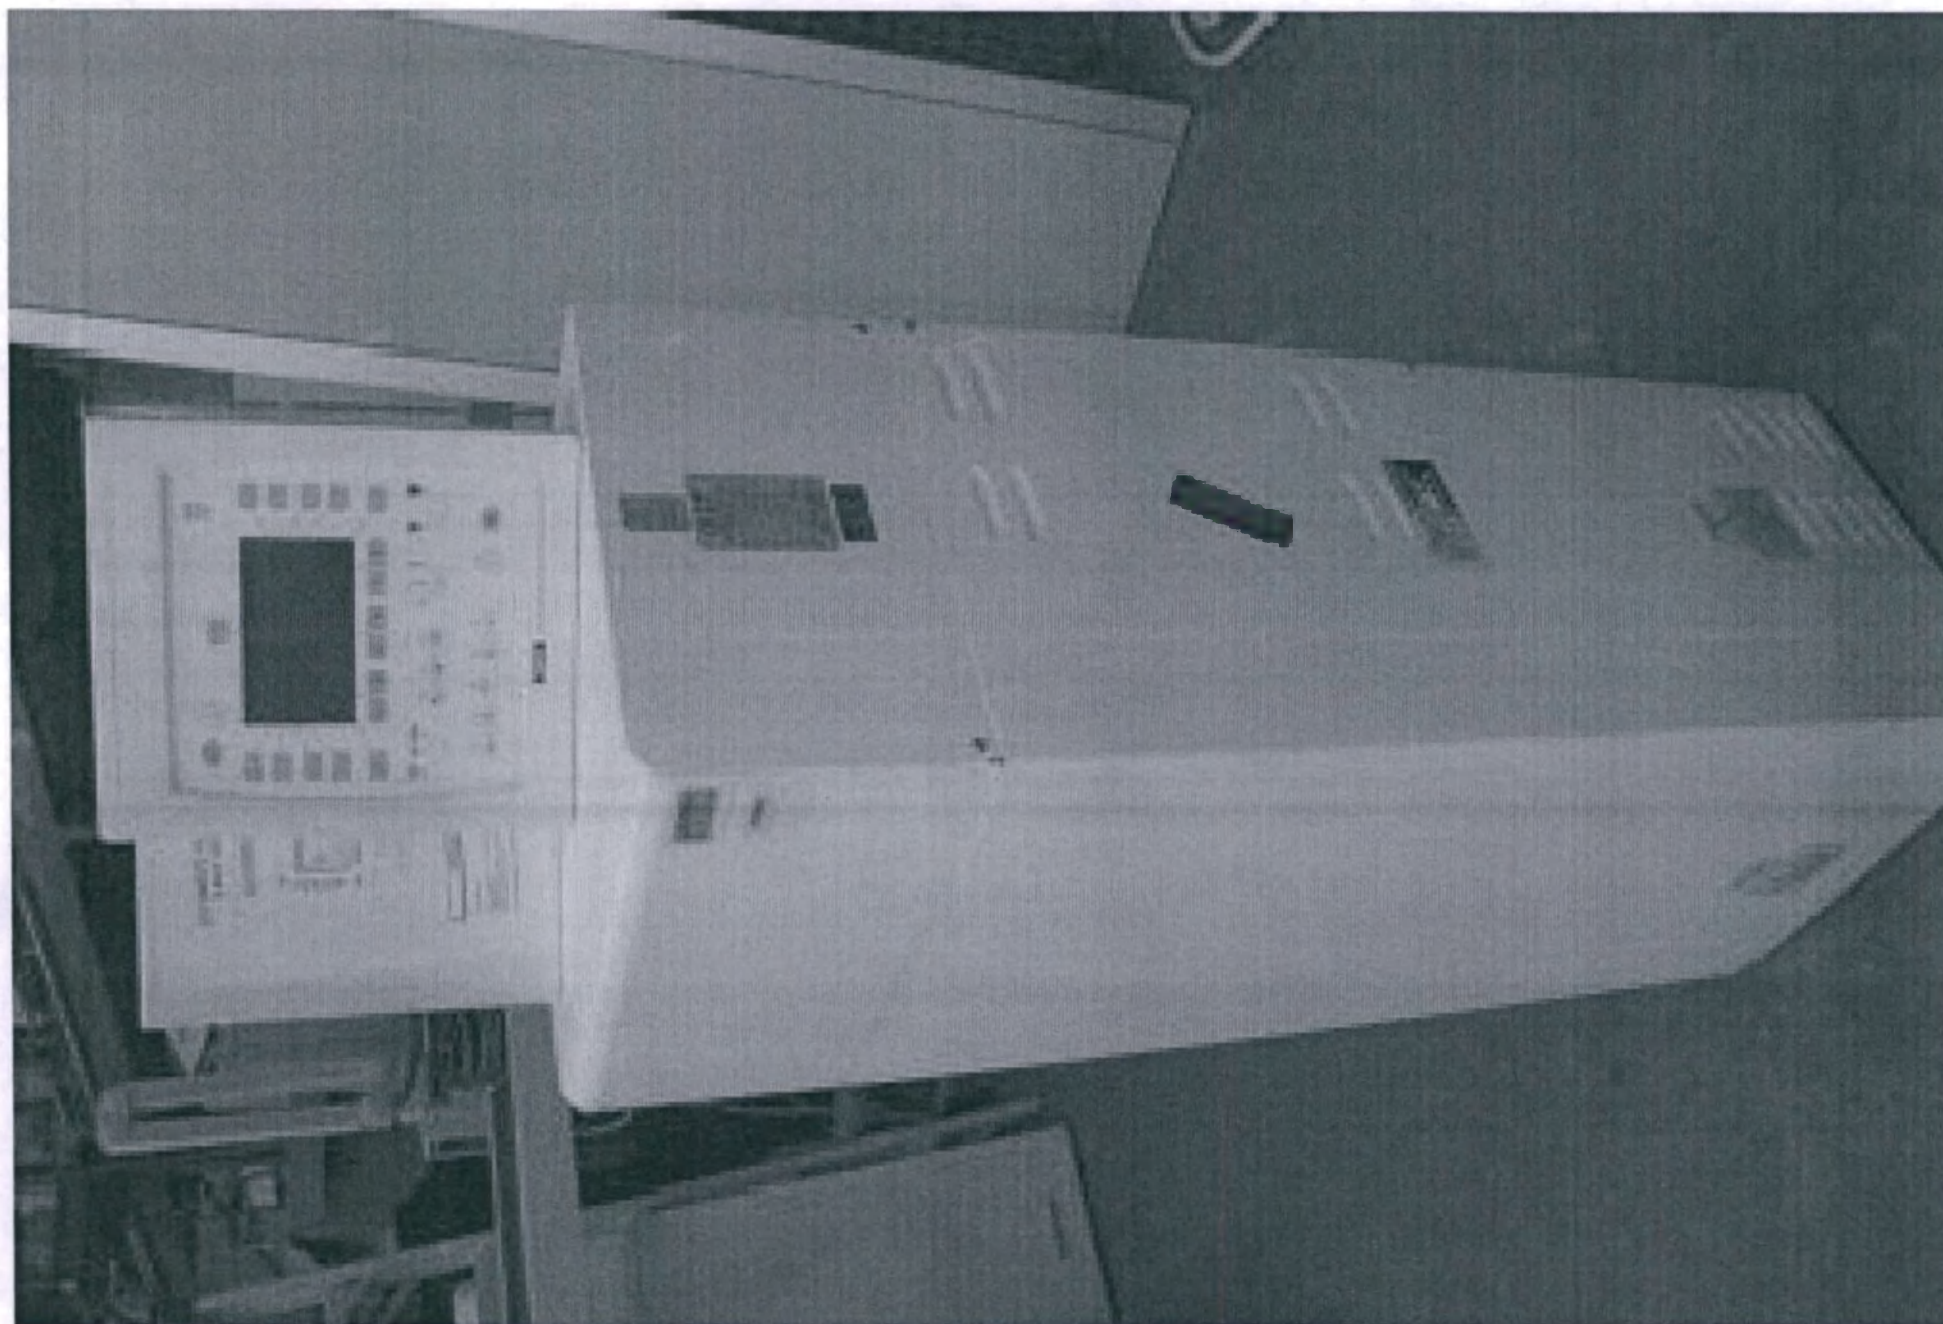


или Z, HFE производства Spellman High Voltage Electronics Corporation, США;




или Polydoros RF; Polydoros RF Rad производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

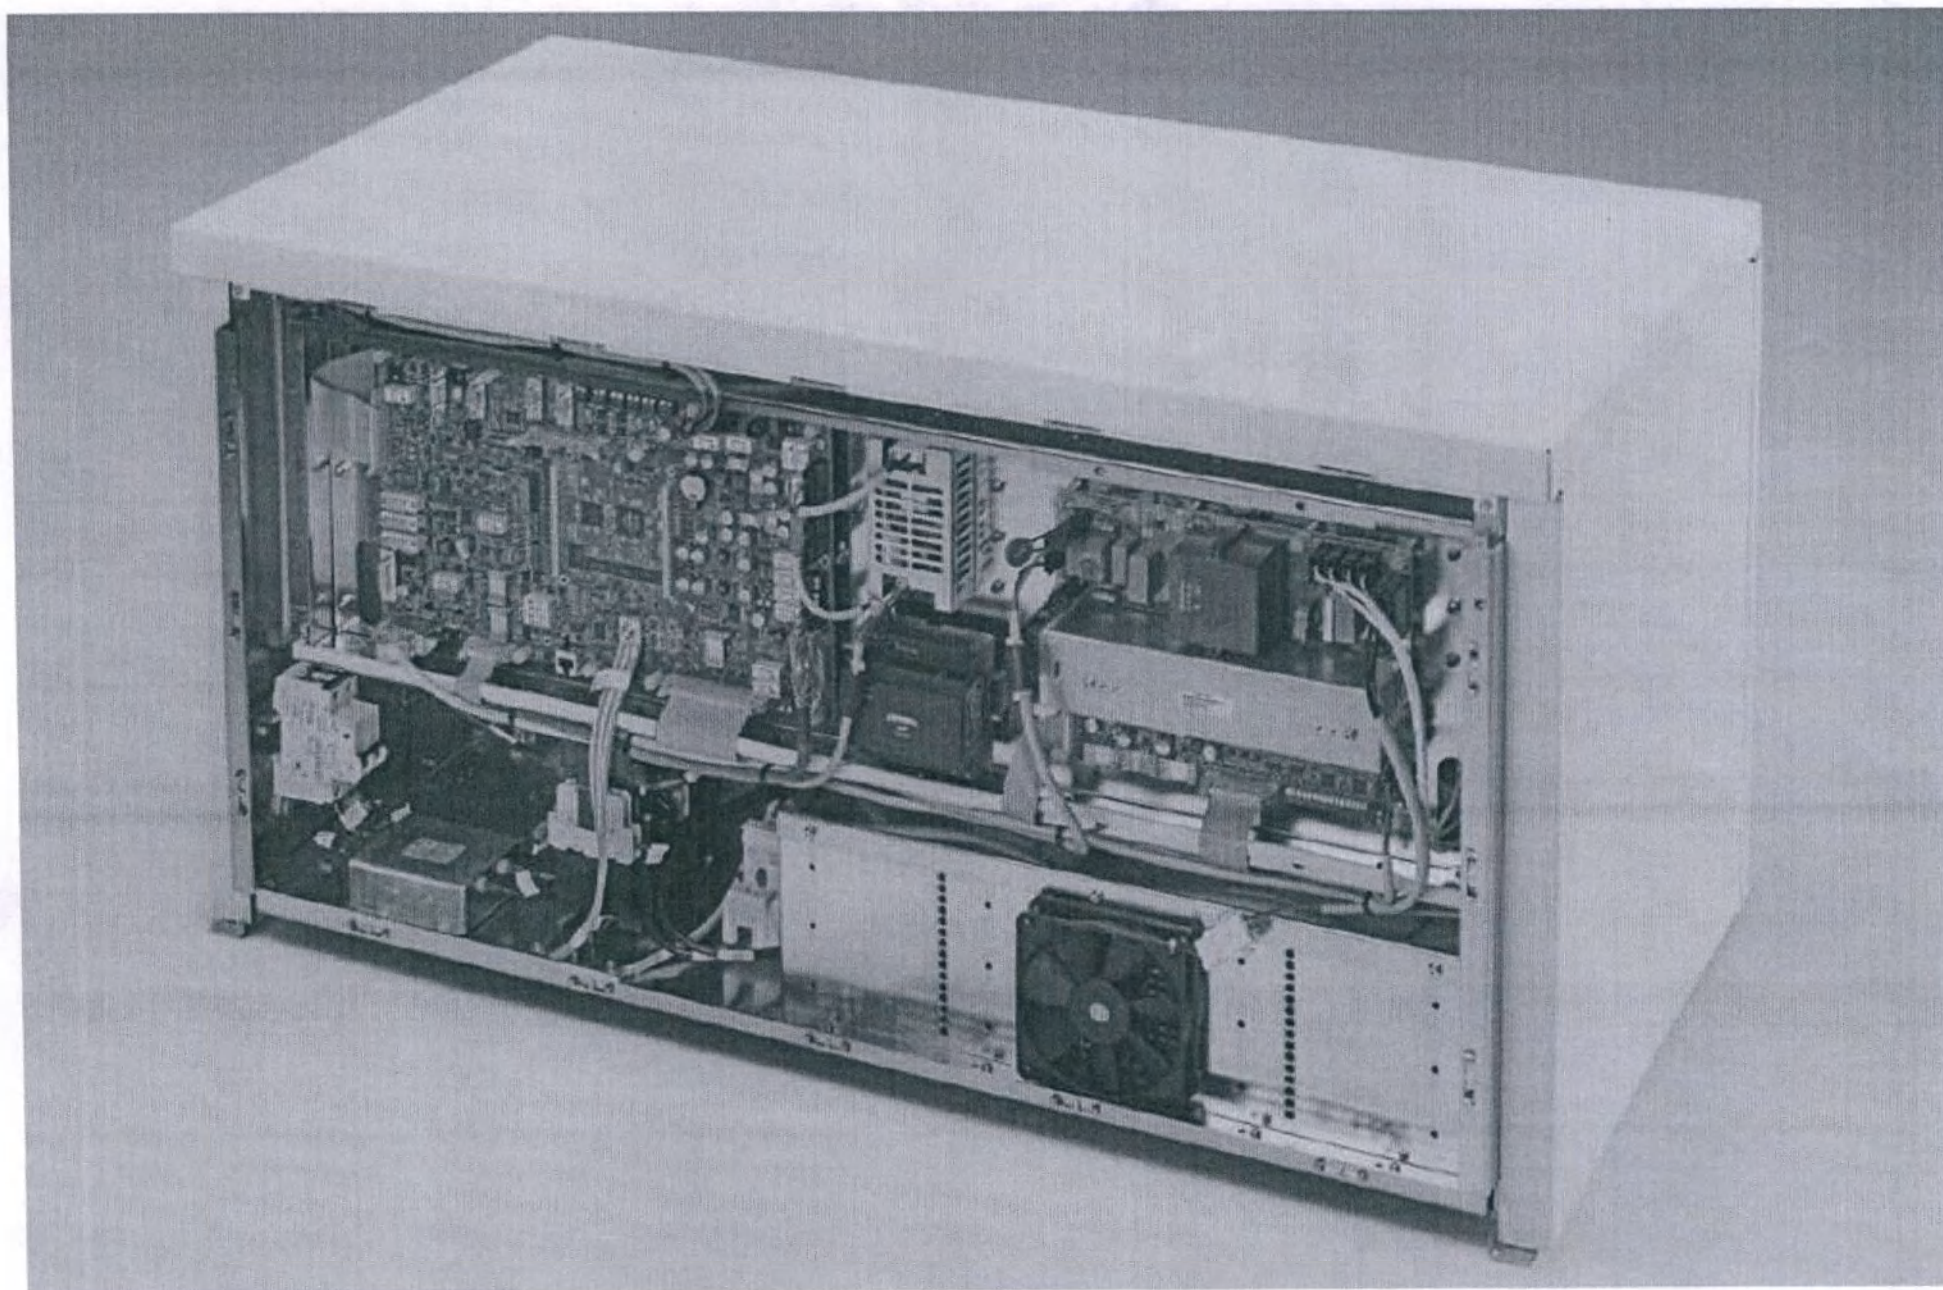


2. Стол поворотный Орега производства General Medical Merate SPA (GMM), Италия;

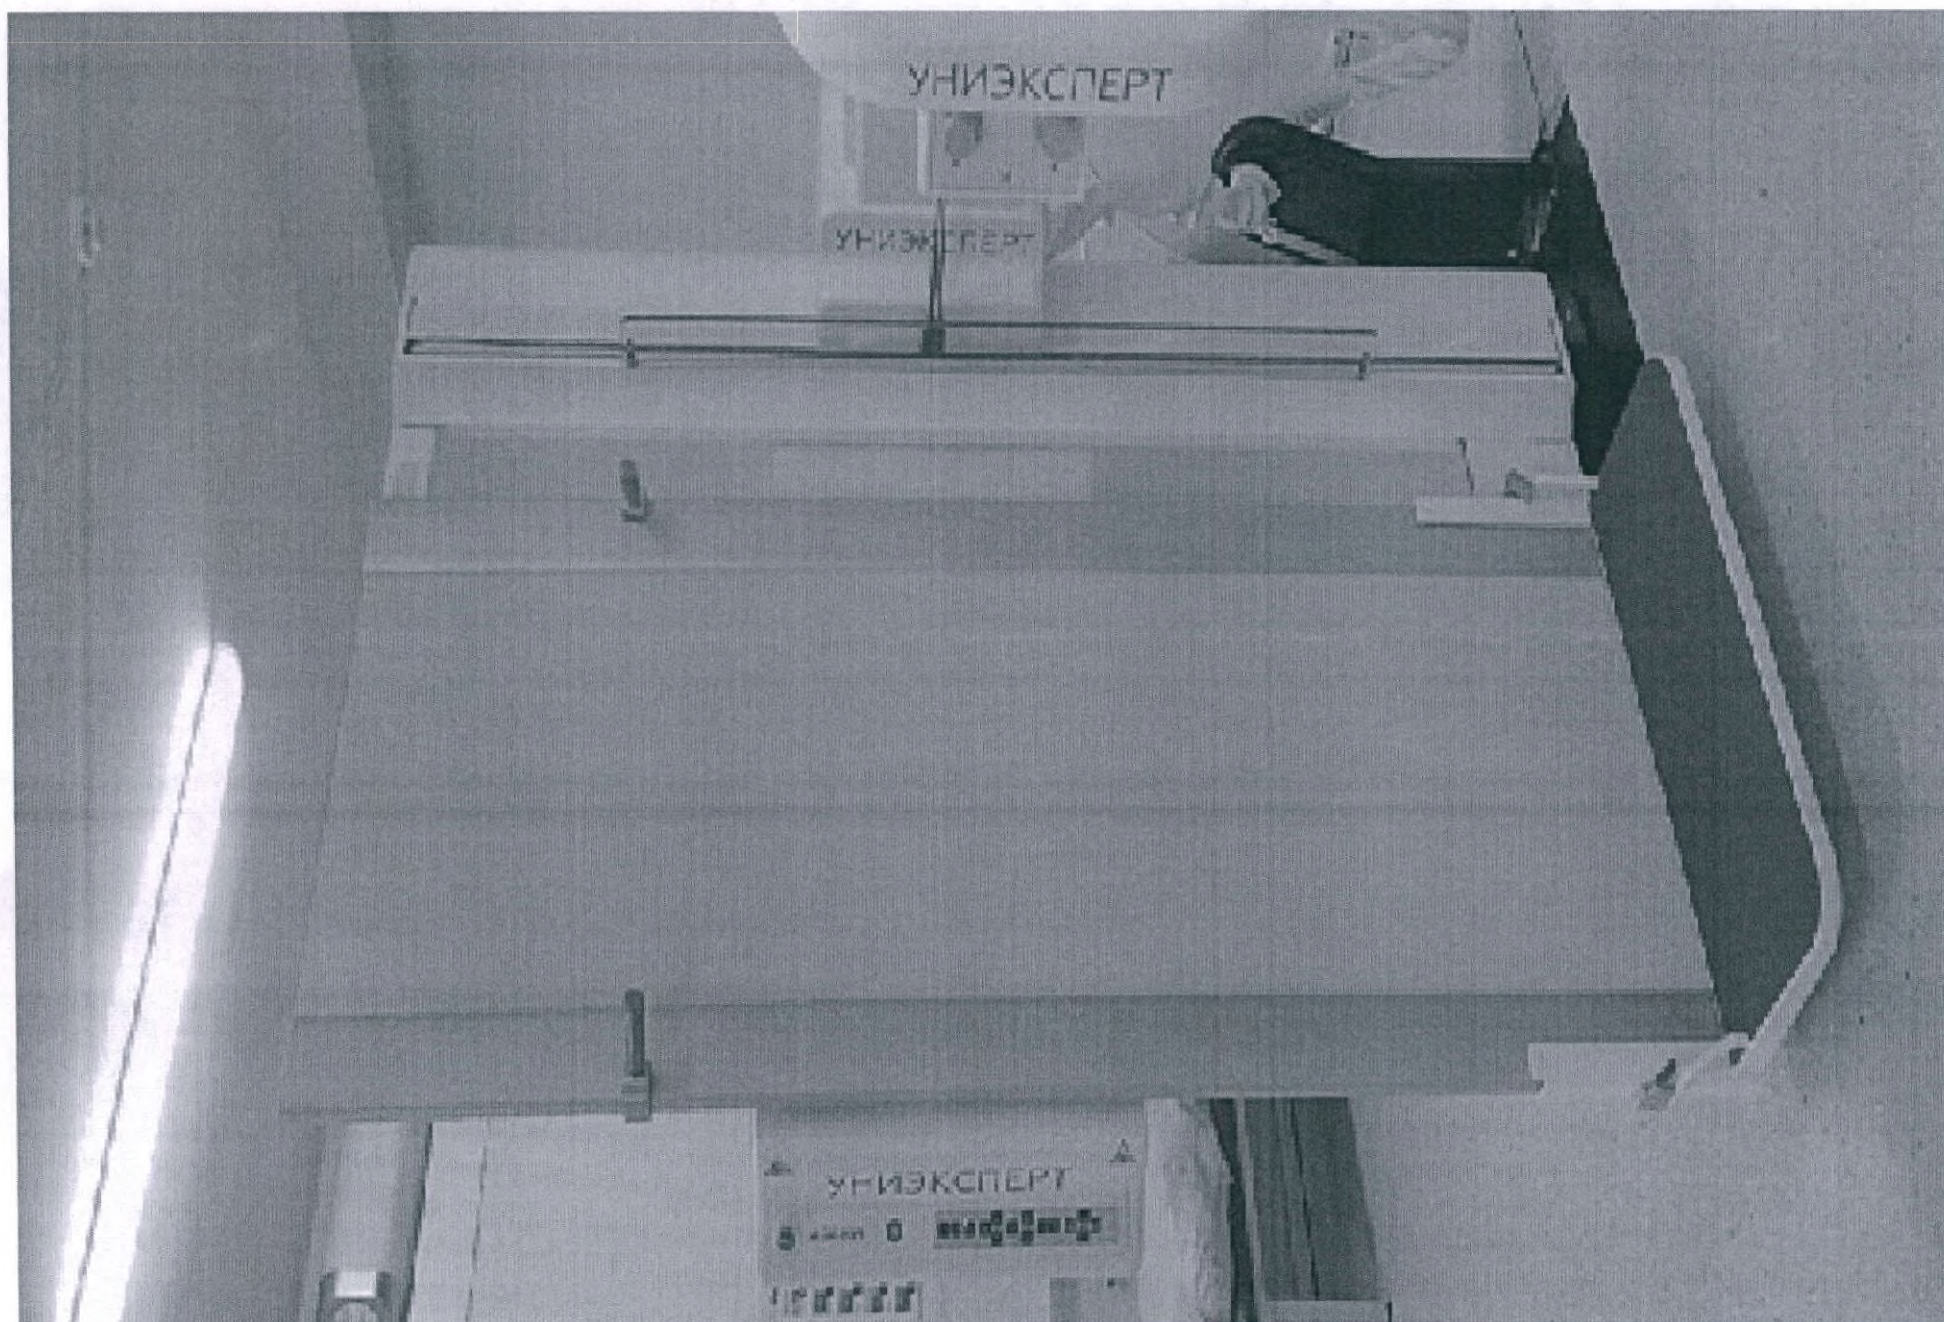


или Apollo производства VILLA SISTEMI MEDICALI s.p.a., Италия;

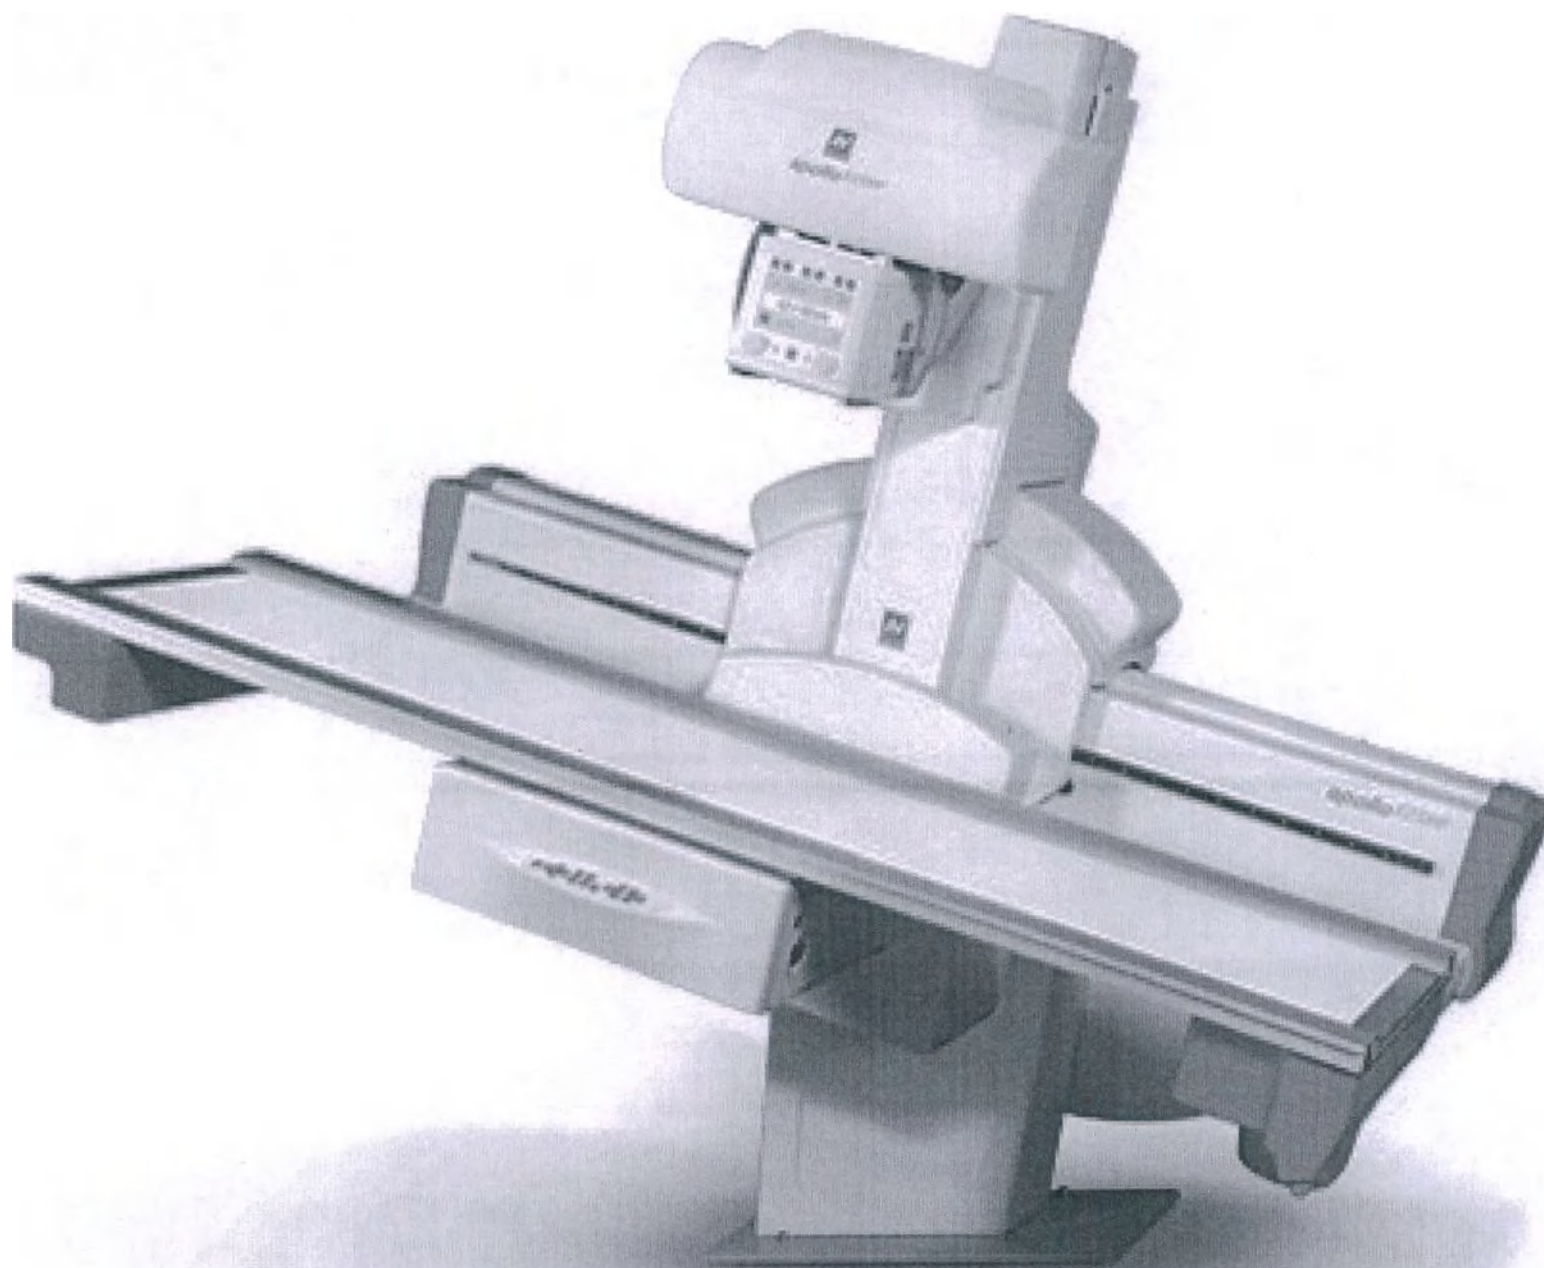

или серии АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

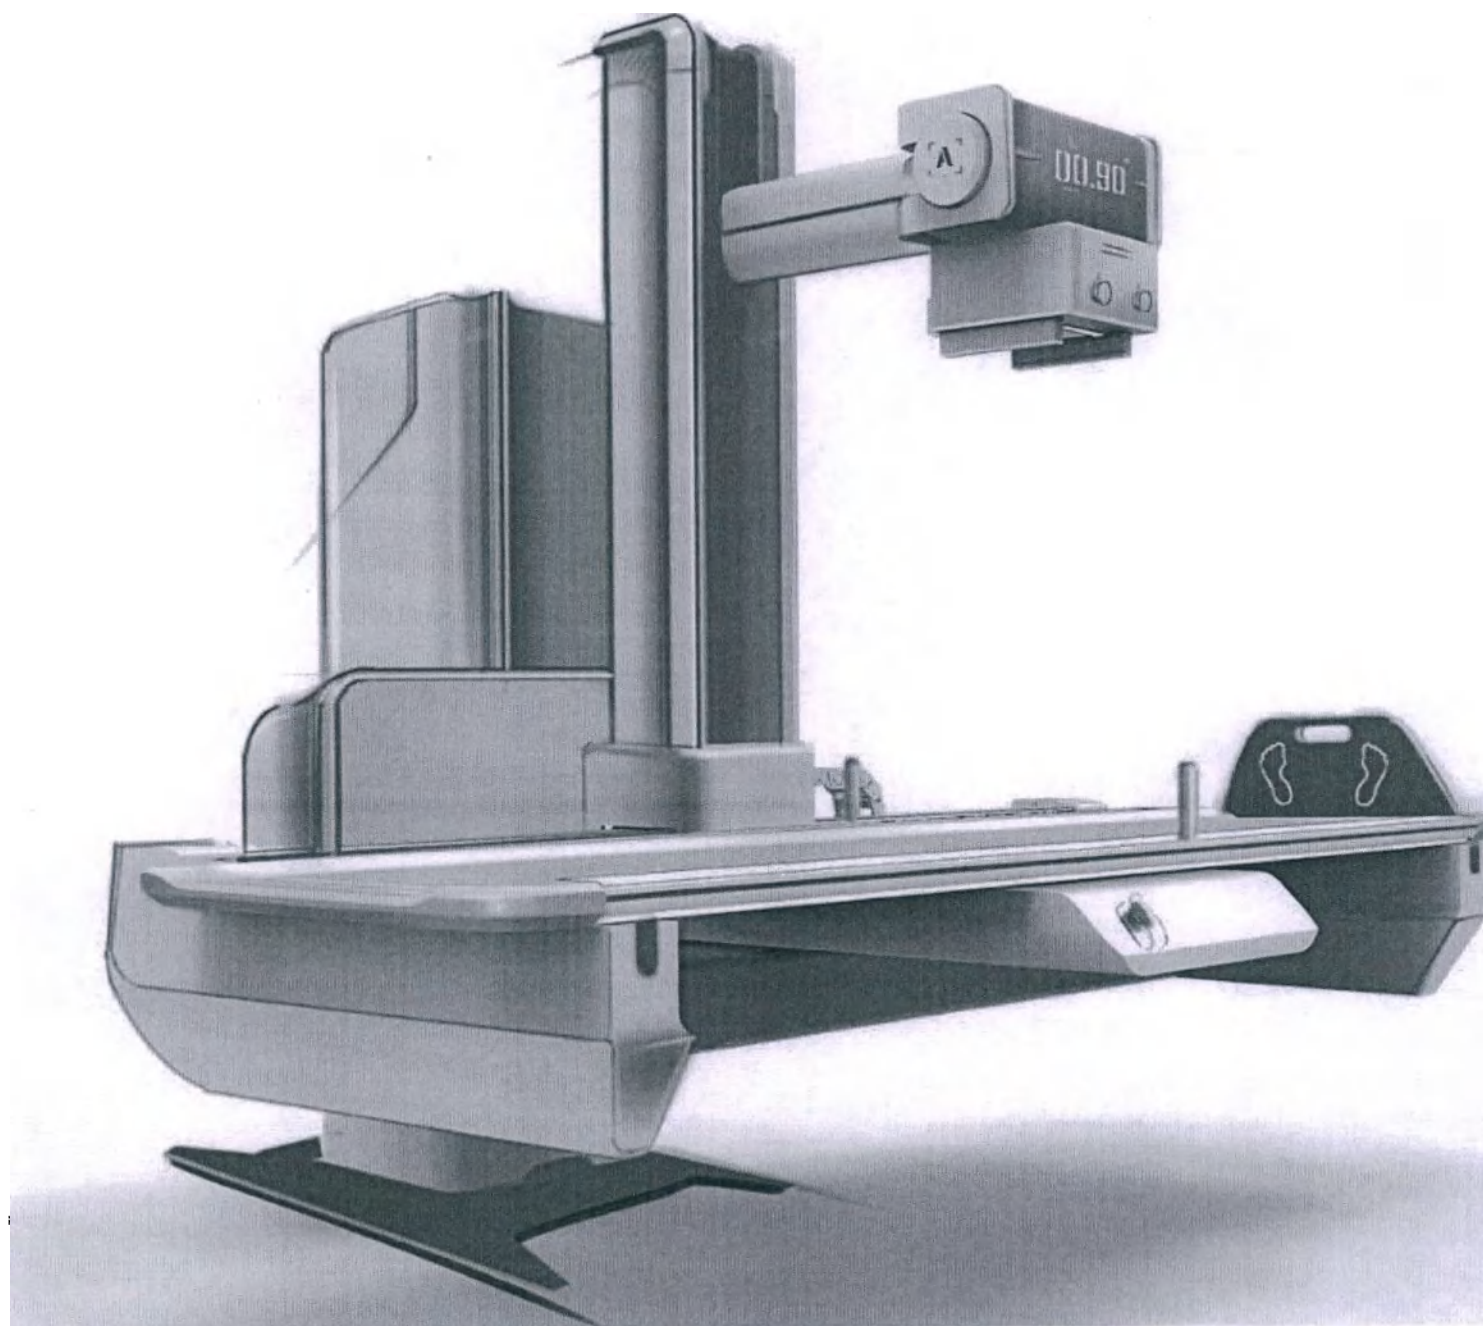


3. Рентгеновский излучатель Е; ЕХ производства Canon Medical System Corporation, Япония;

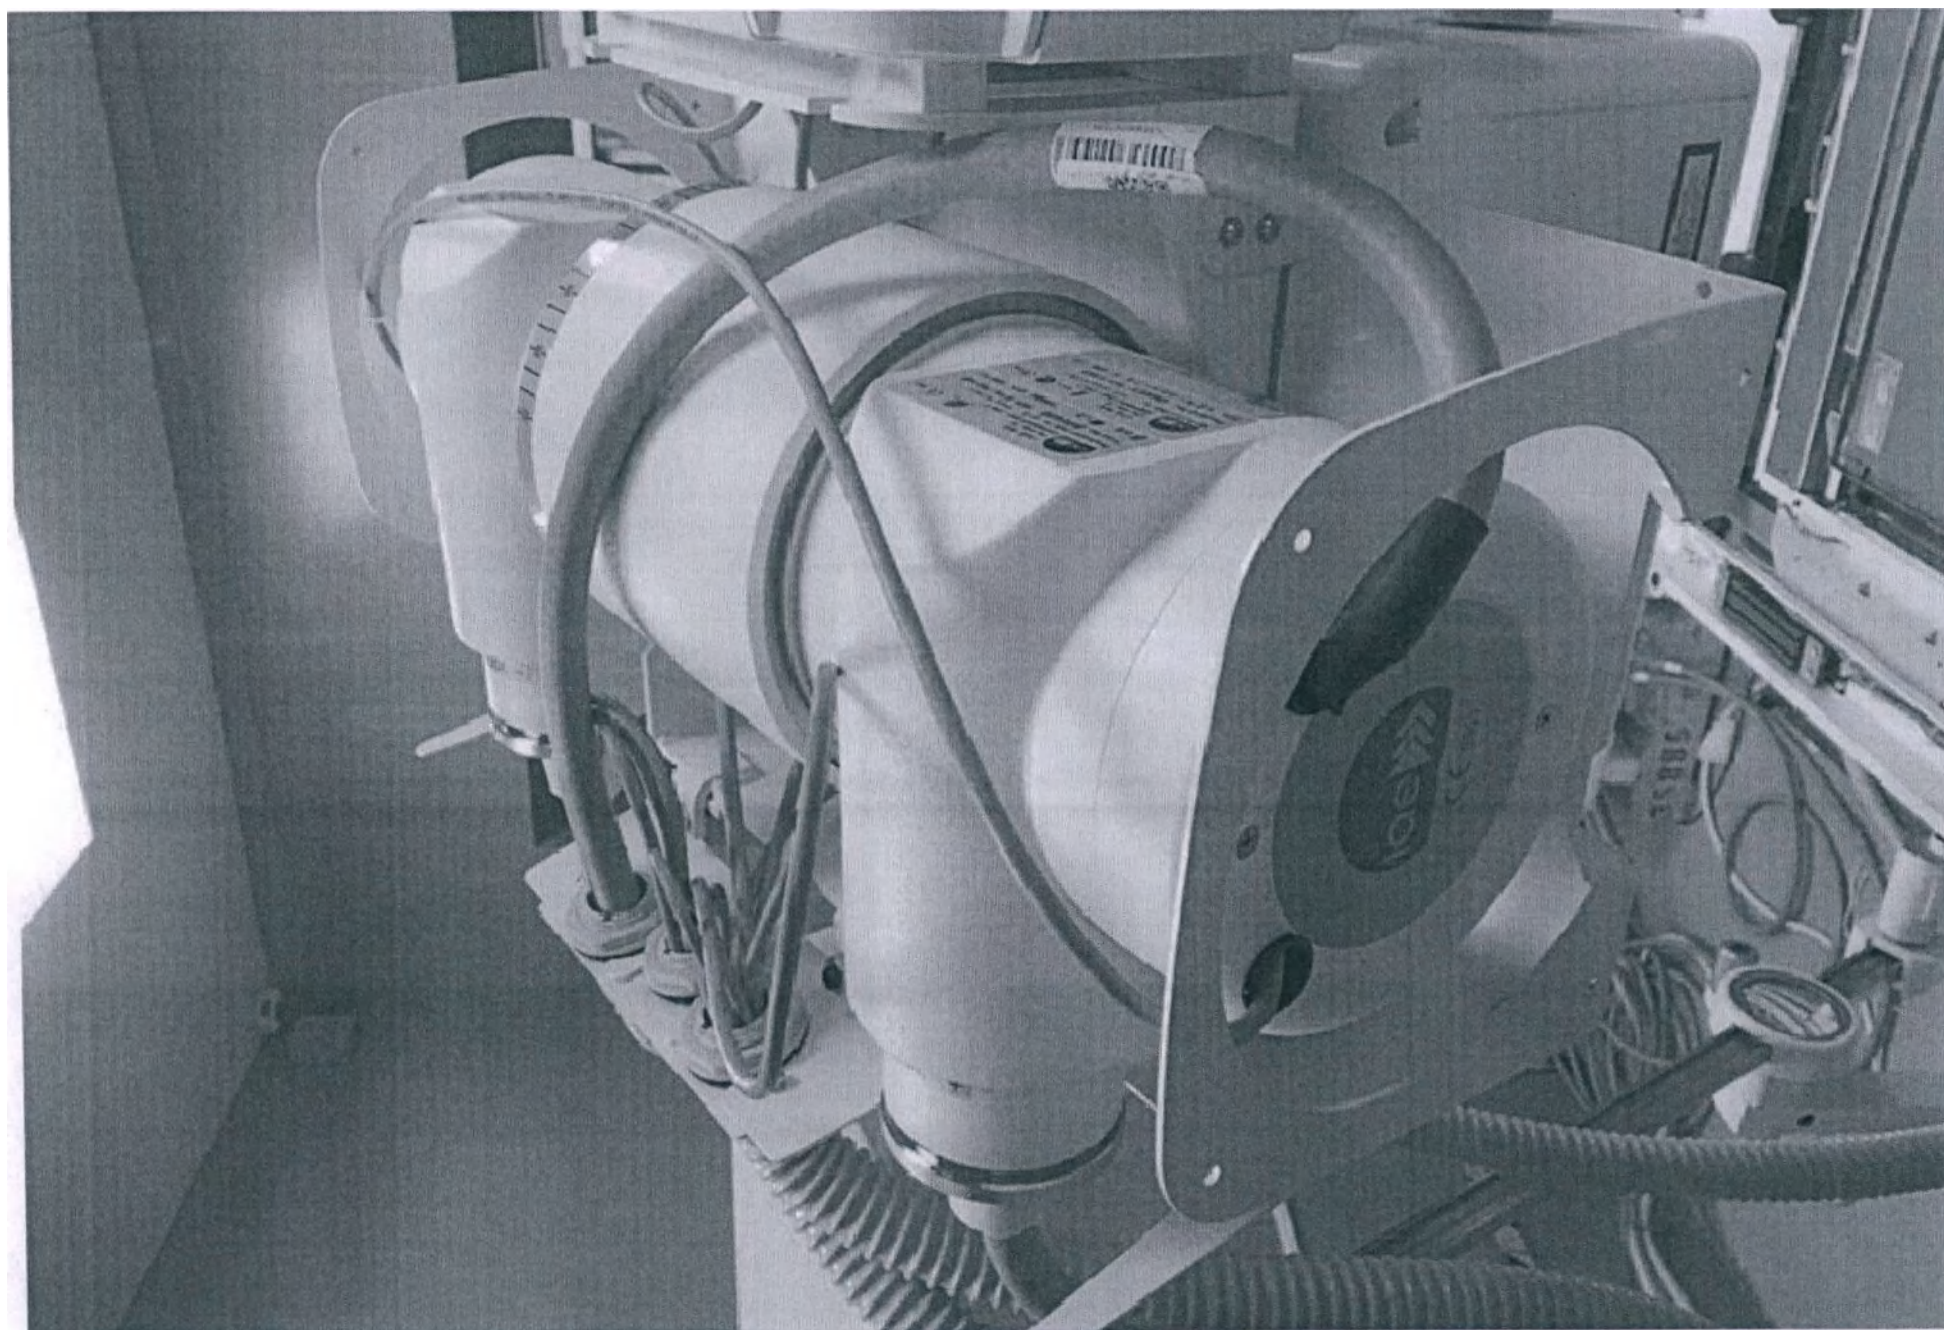


или X, RTM, RTC производства I.A.E Industria Applicazioni Elettroniche S.P.A., Италия;




или A; G; RAD; SG; Sapphire, Diamond, CGR производства Varex Imaging Corporation, США;

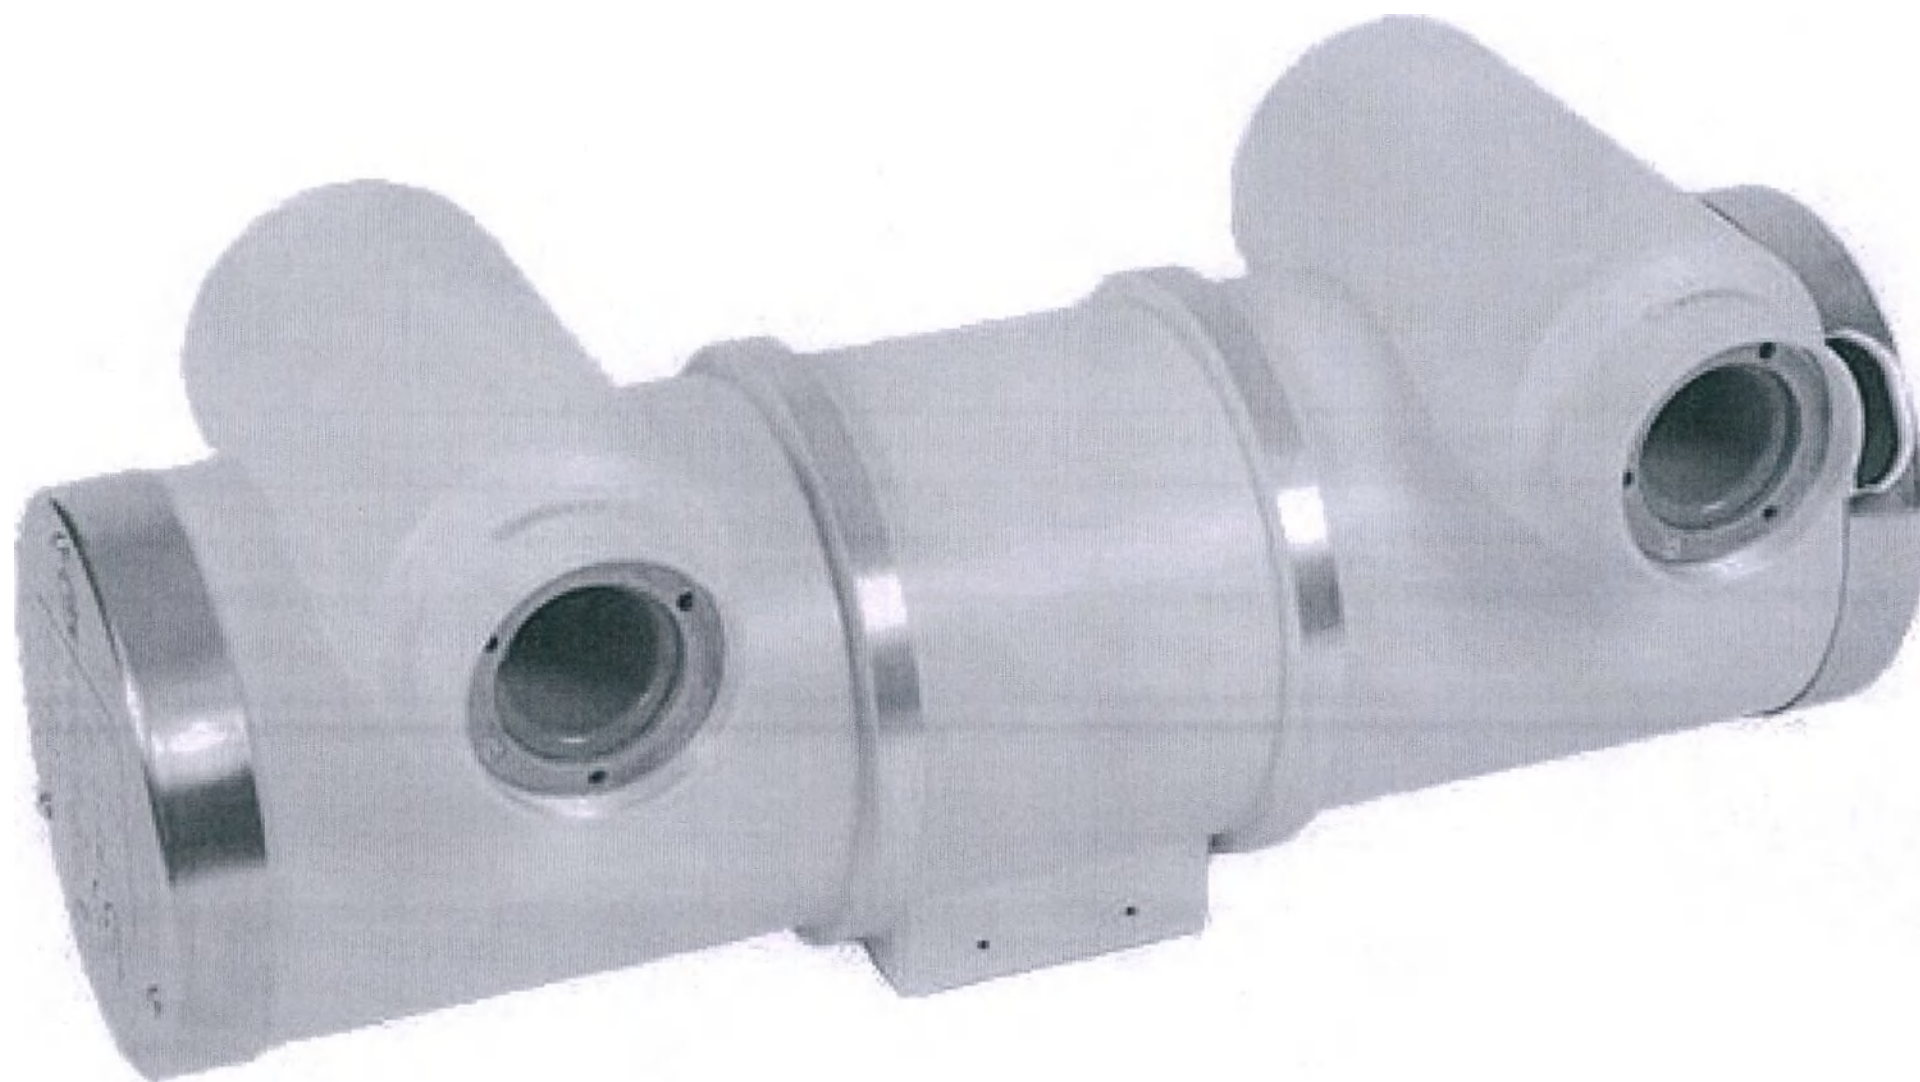


или Р 135/70; 135/30R; 125/10/20 CR производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

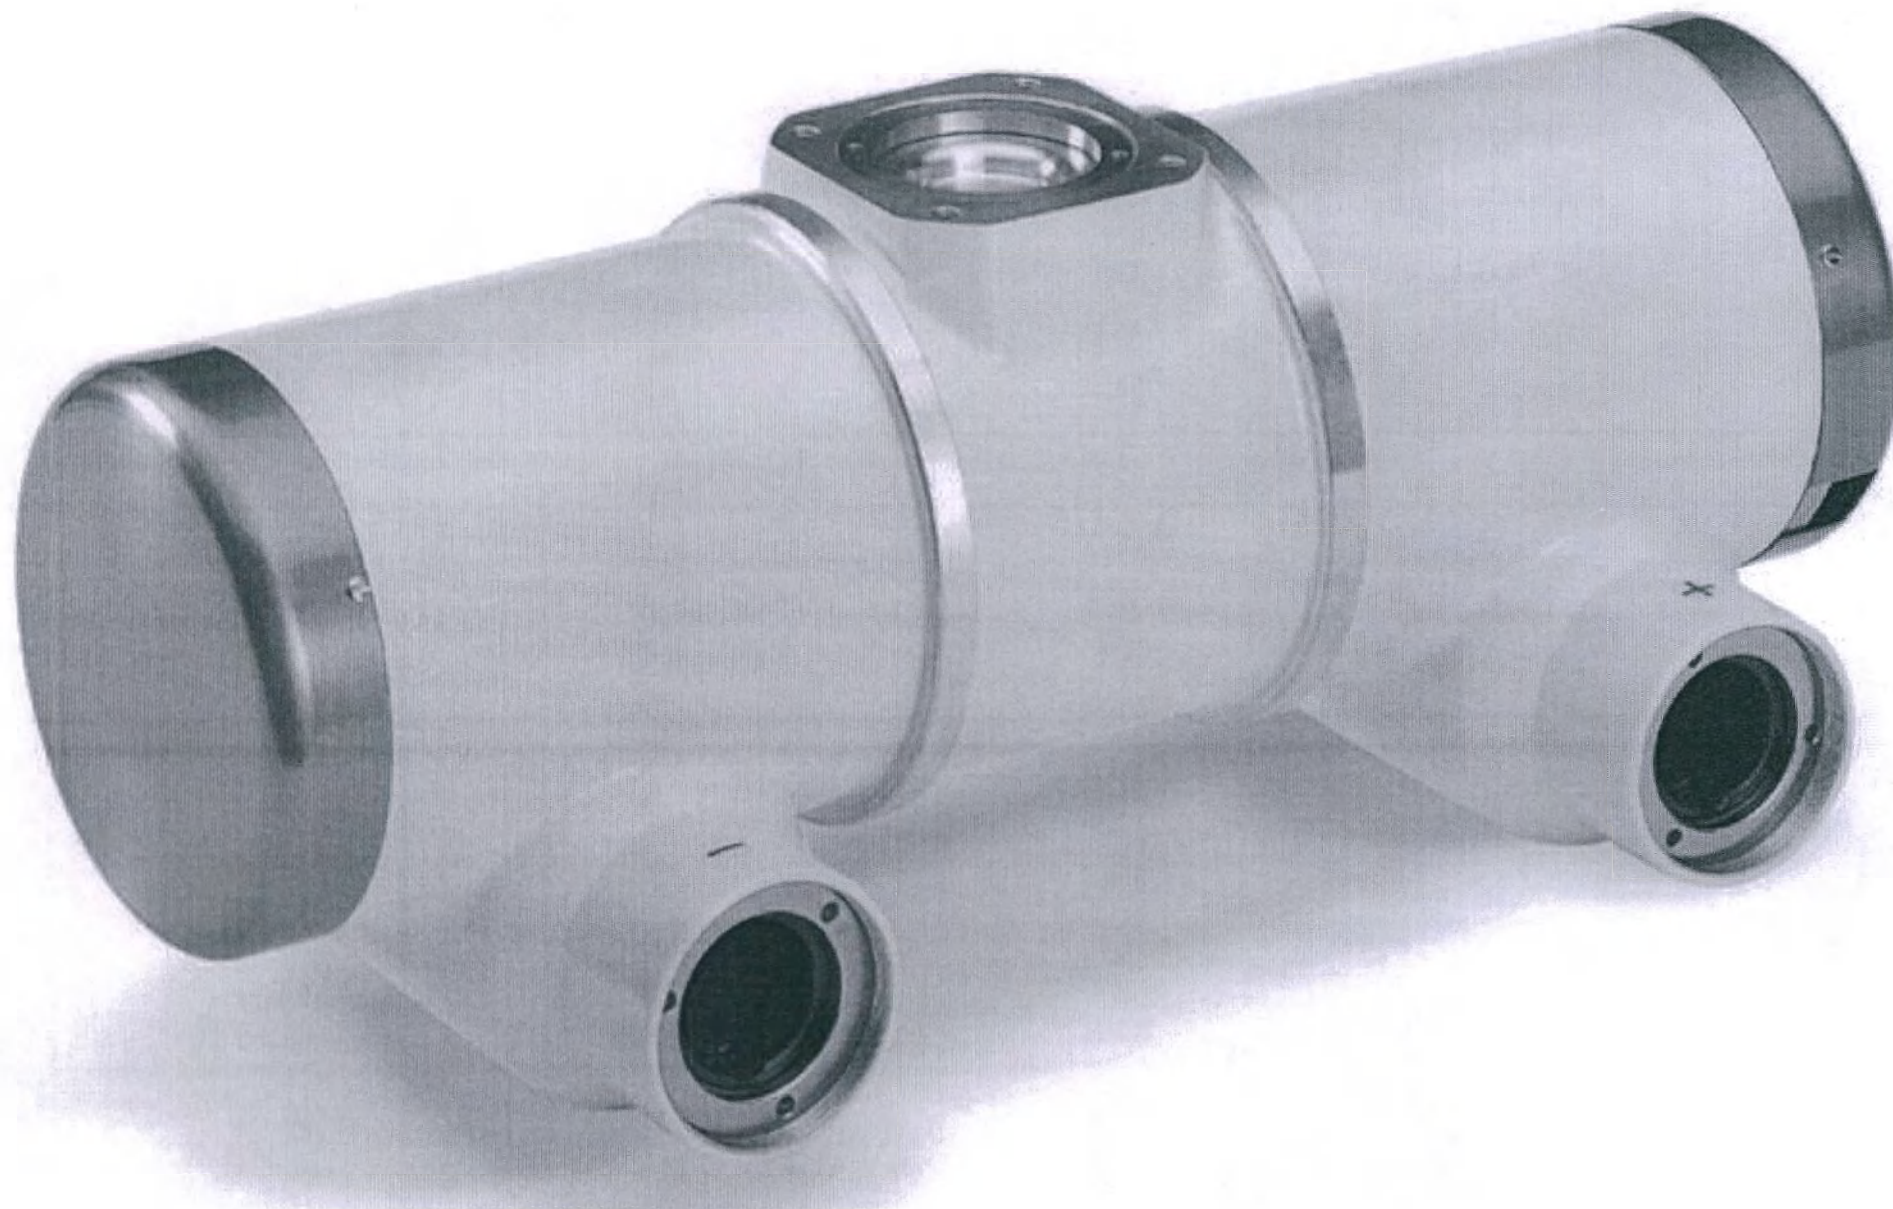


4. Кабели высоковольтные Cable Assy производства Varex Imaging Corporation, Филиппины и Нидерланды;

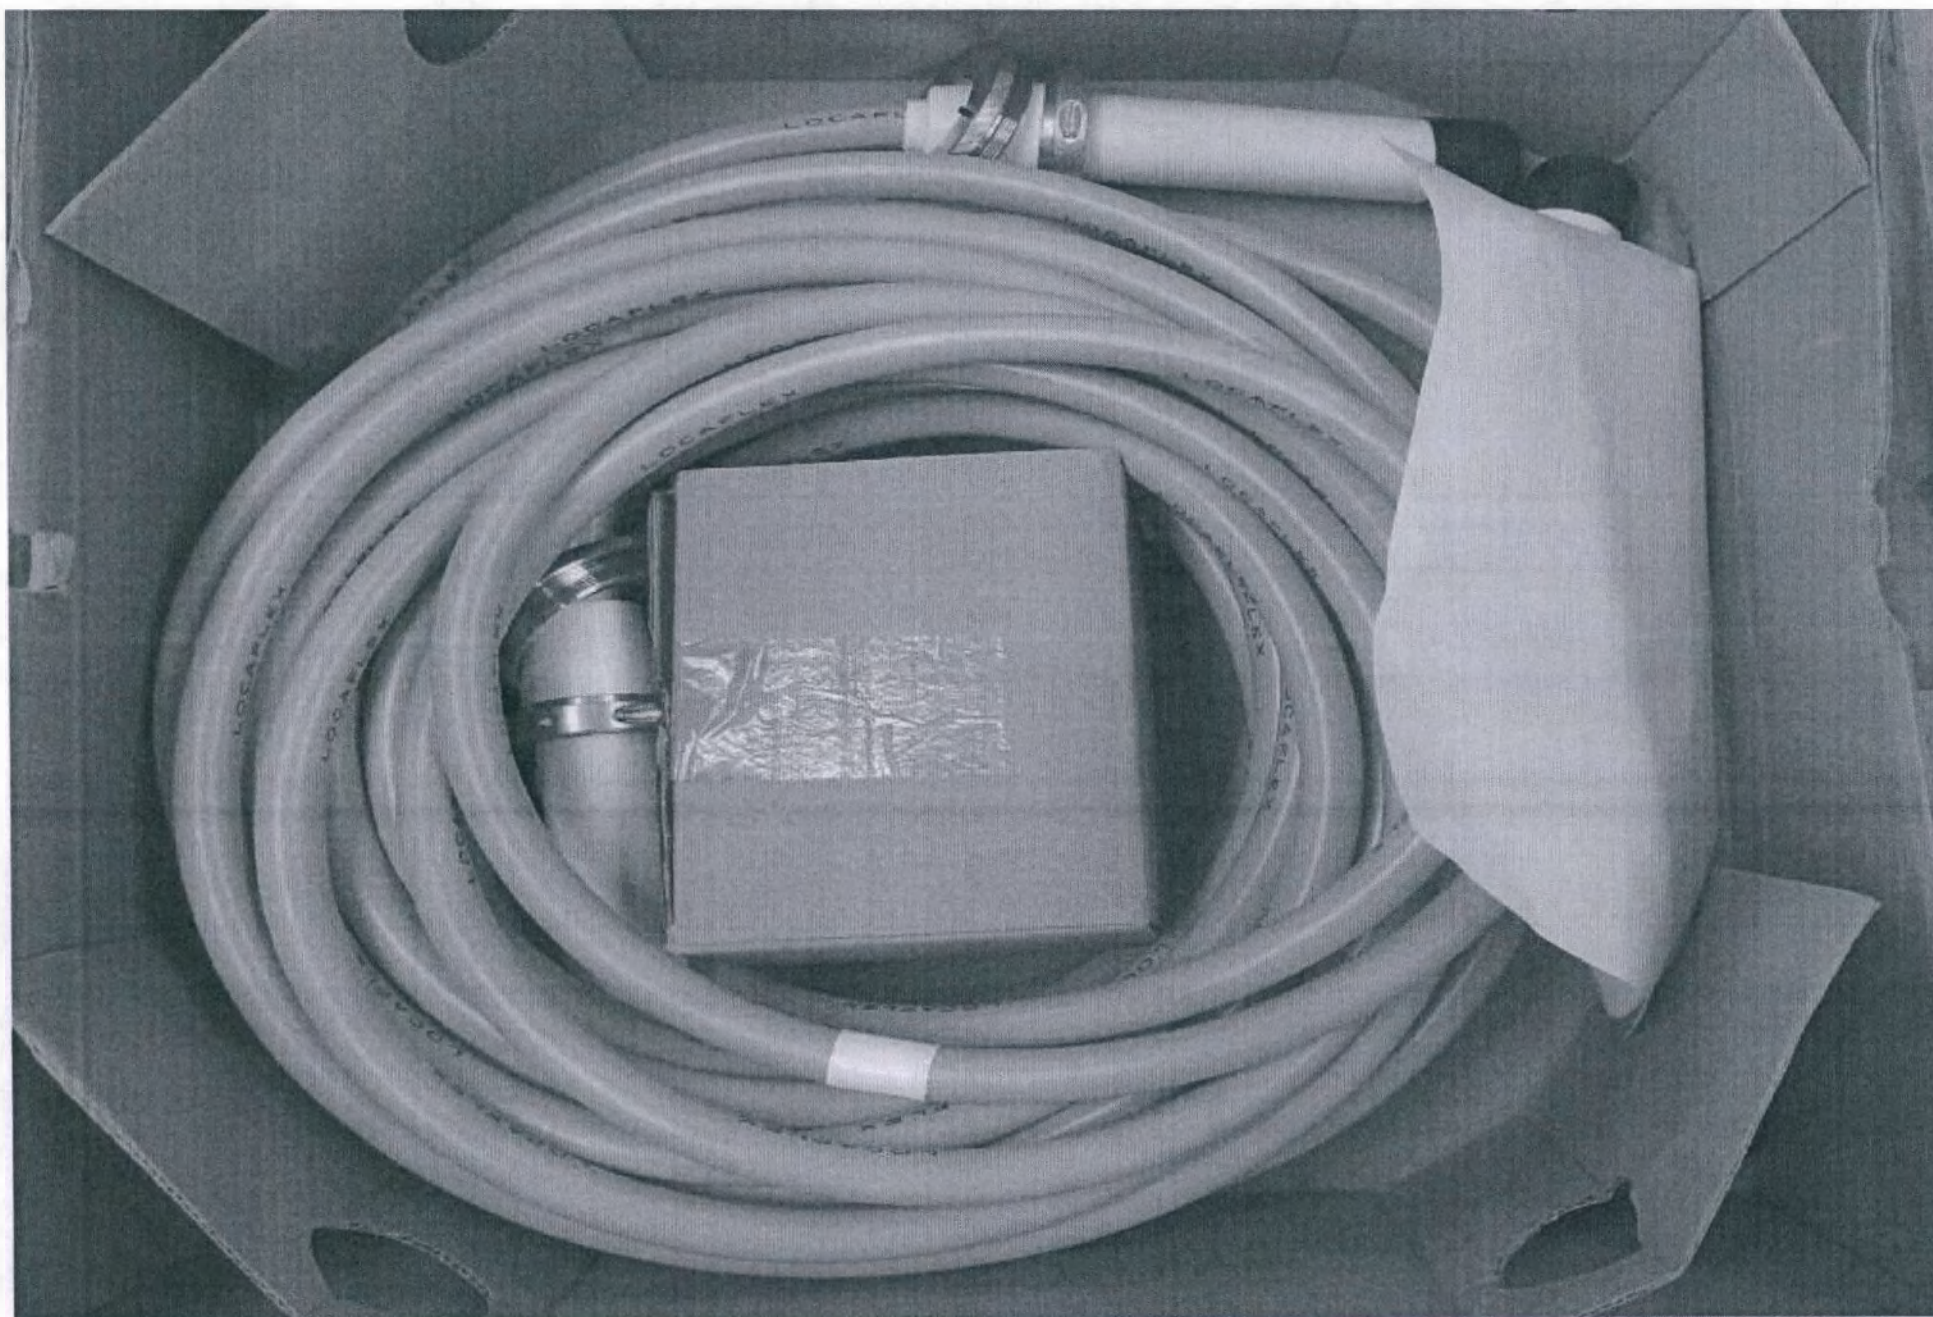

или Roesys HVC, производства Roesys GmbH, Германия; или производства Comet AG, Швейцария

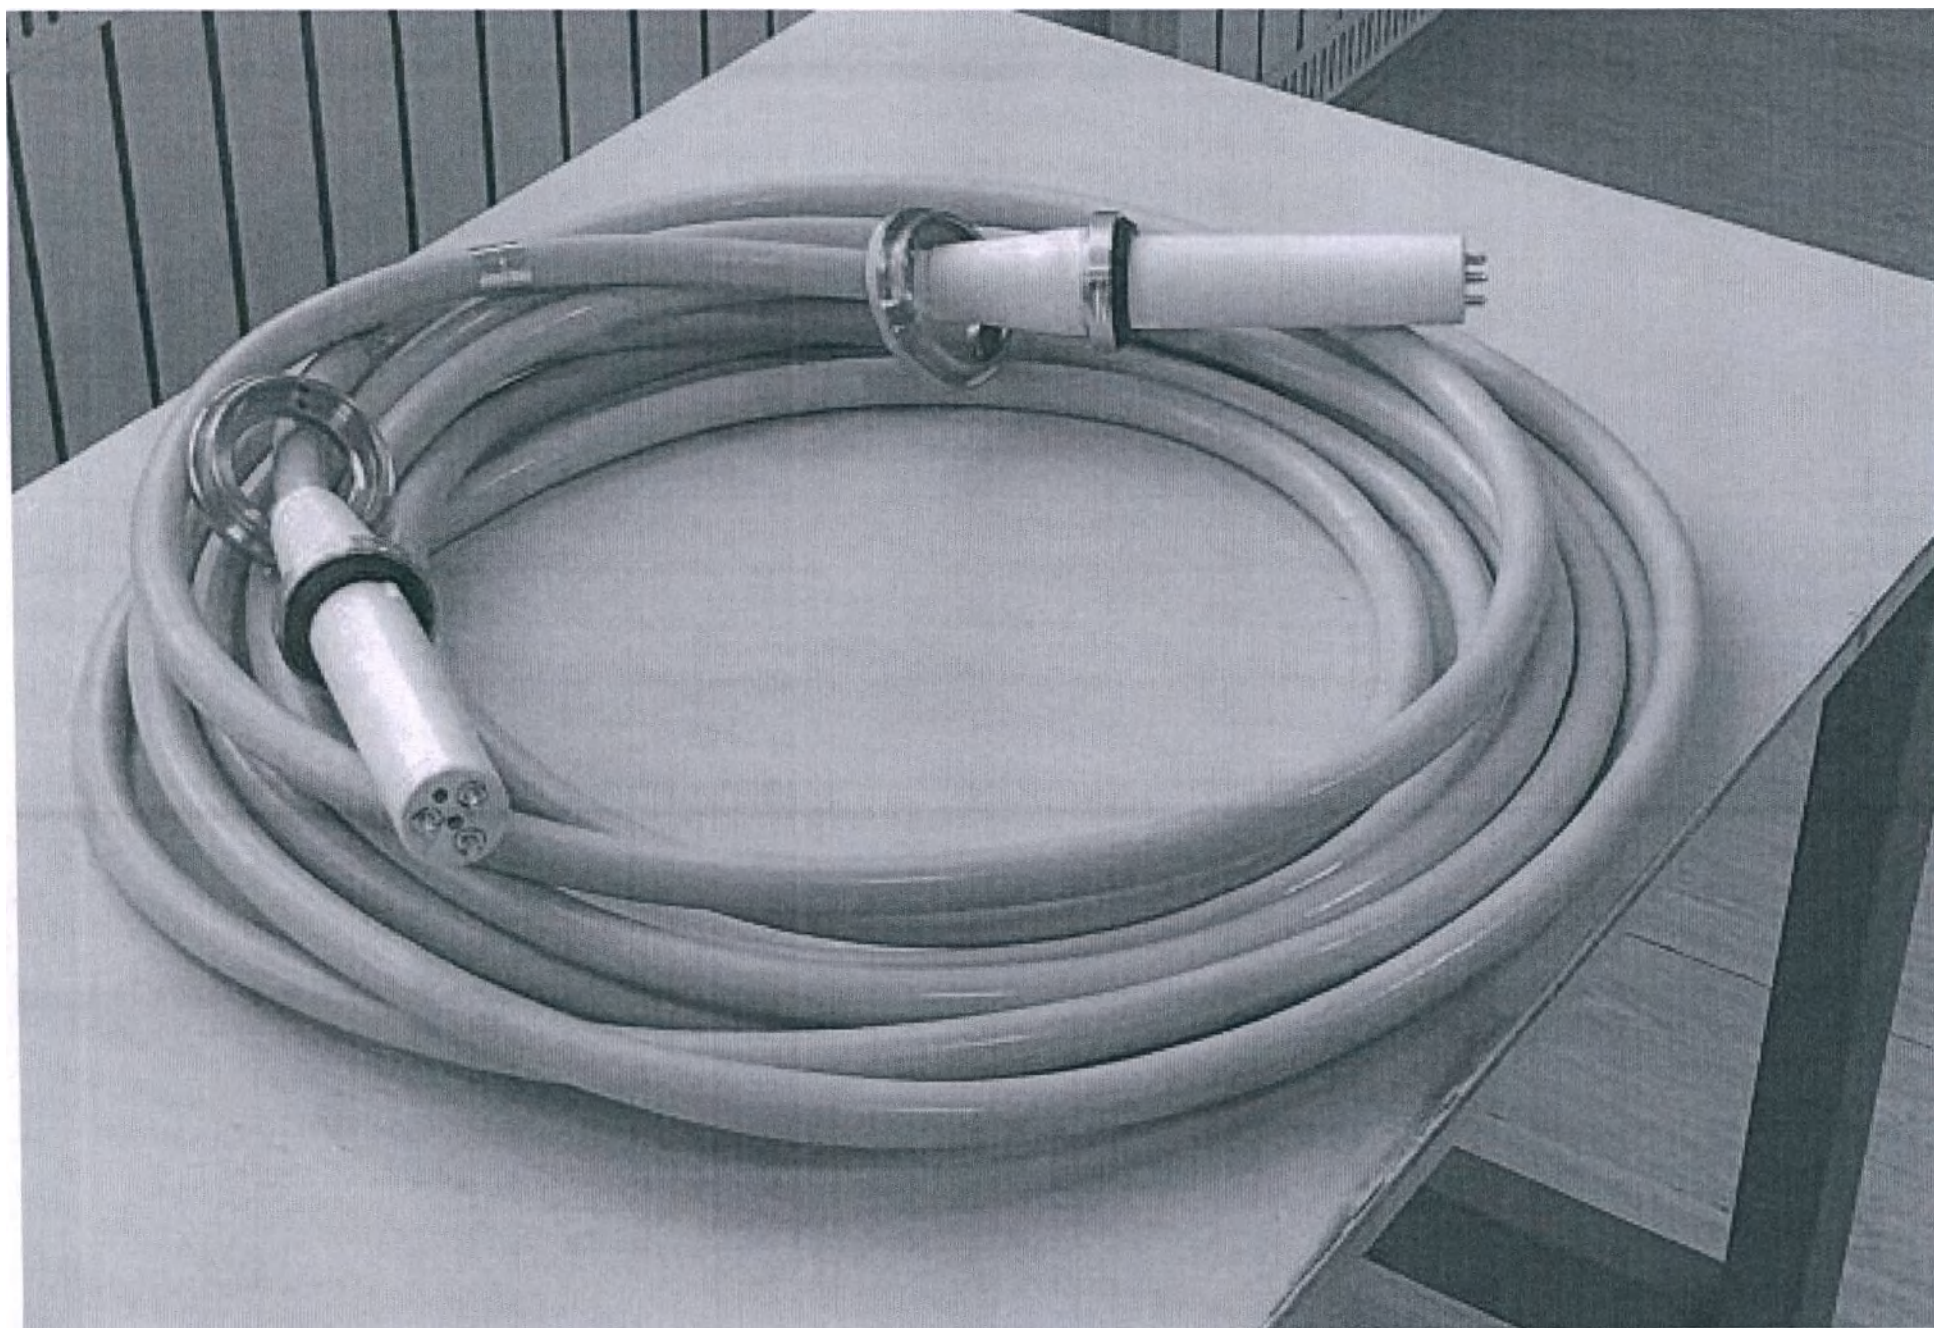


5. Коллиматор (рентгеновская диафрагма) R, производства Ralco S.r.l, Италия;

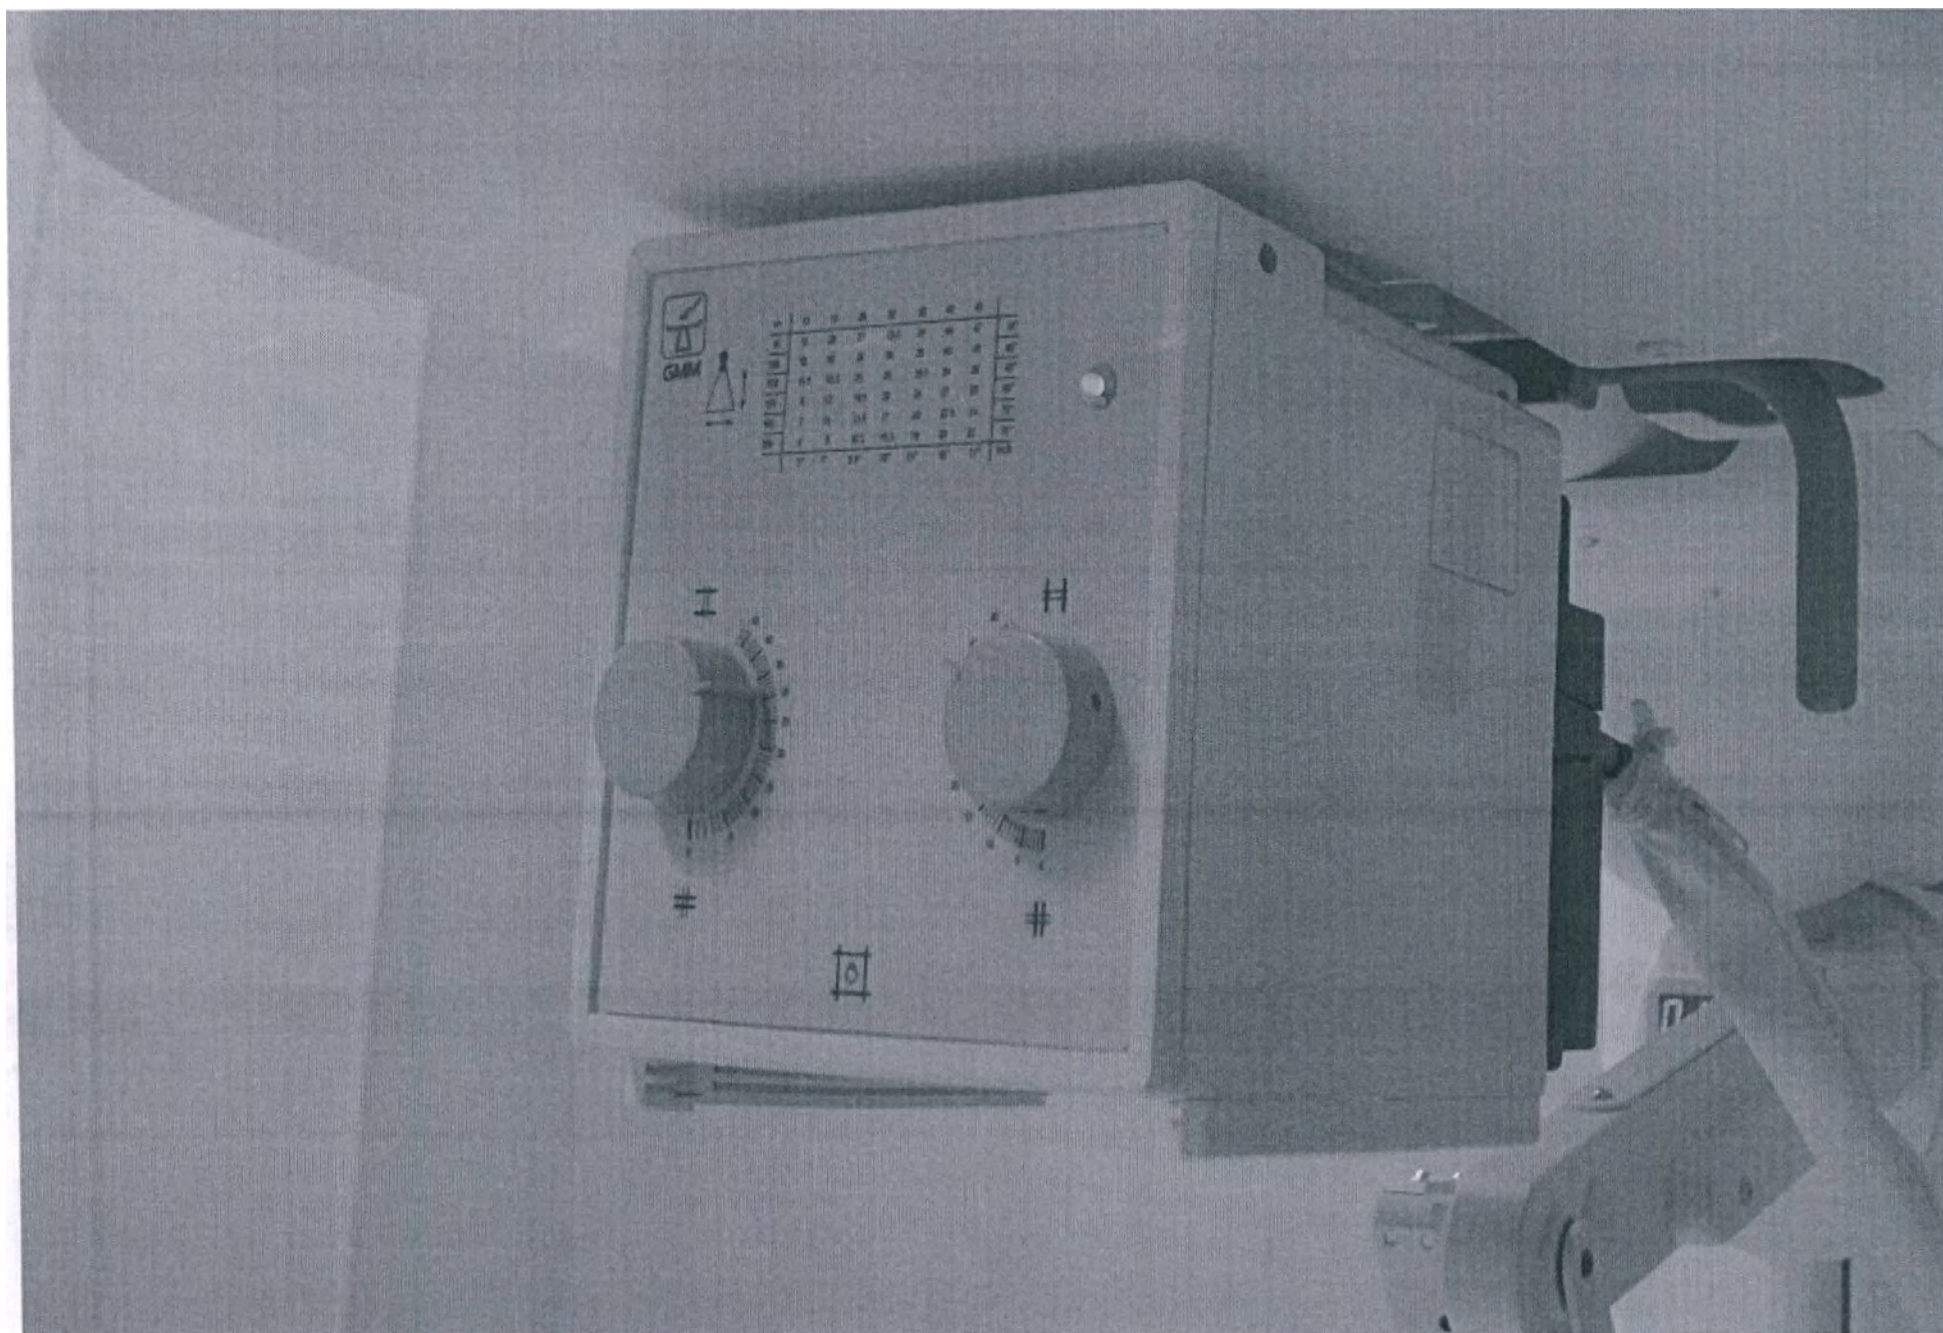

или СМ производства Huestis Medical, США;



или ML; AL; A; AF; AFL производства Siemens Healthcare GmbH, Германия;

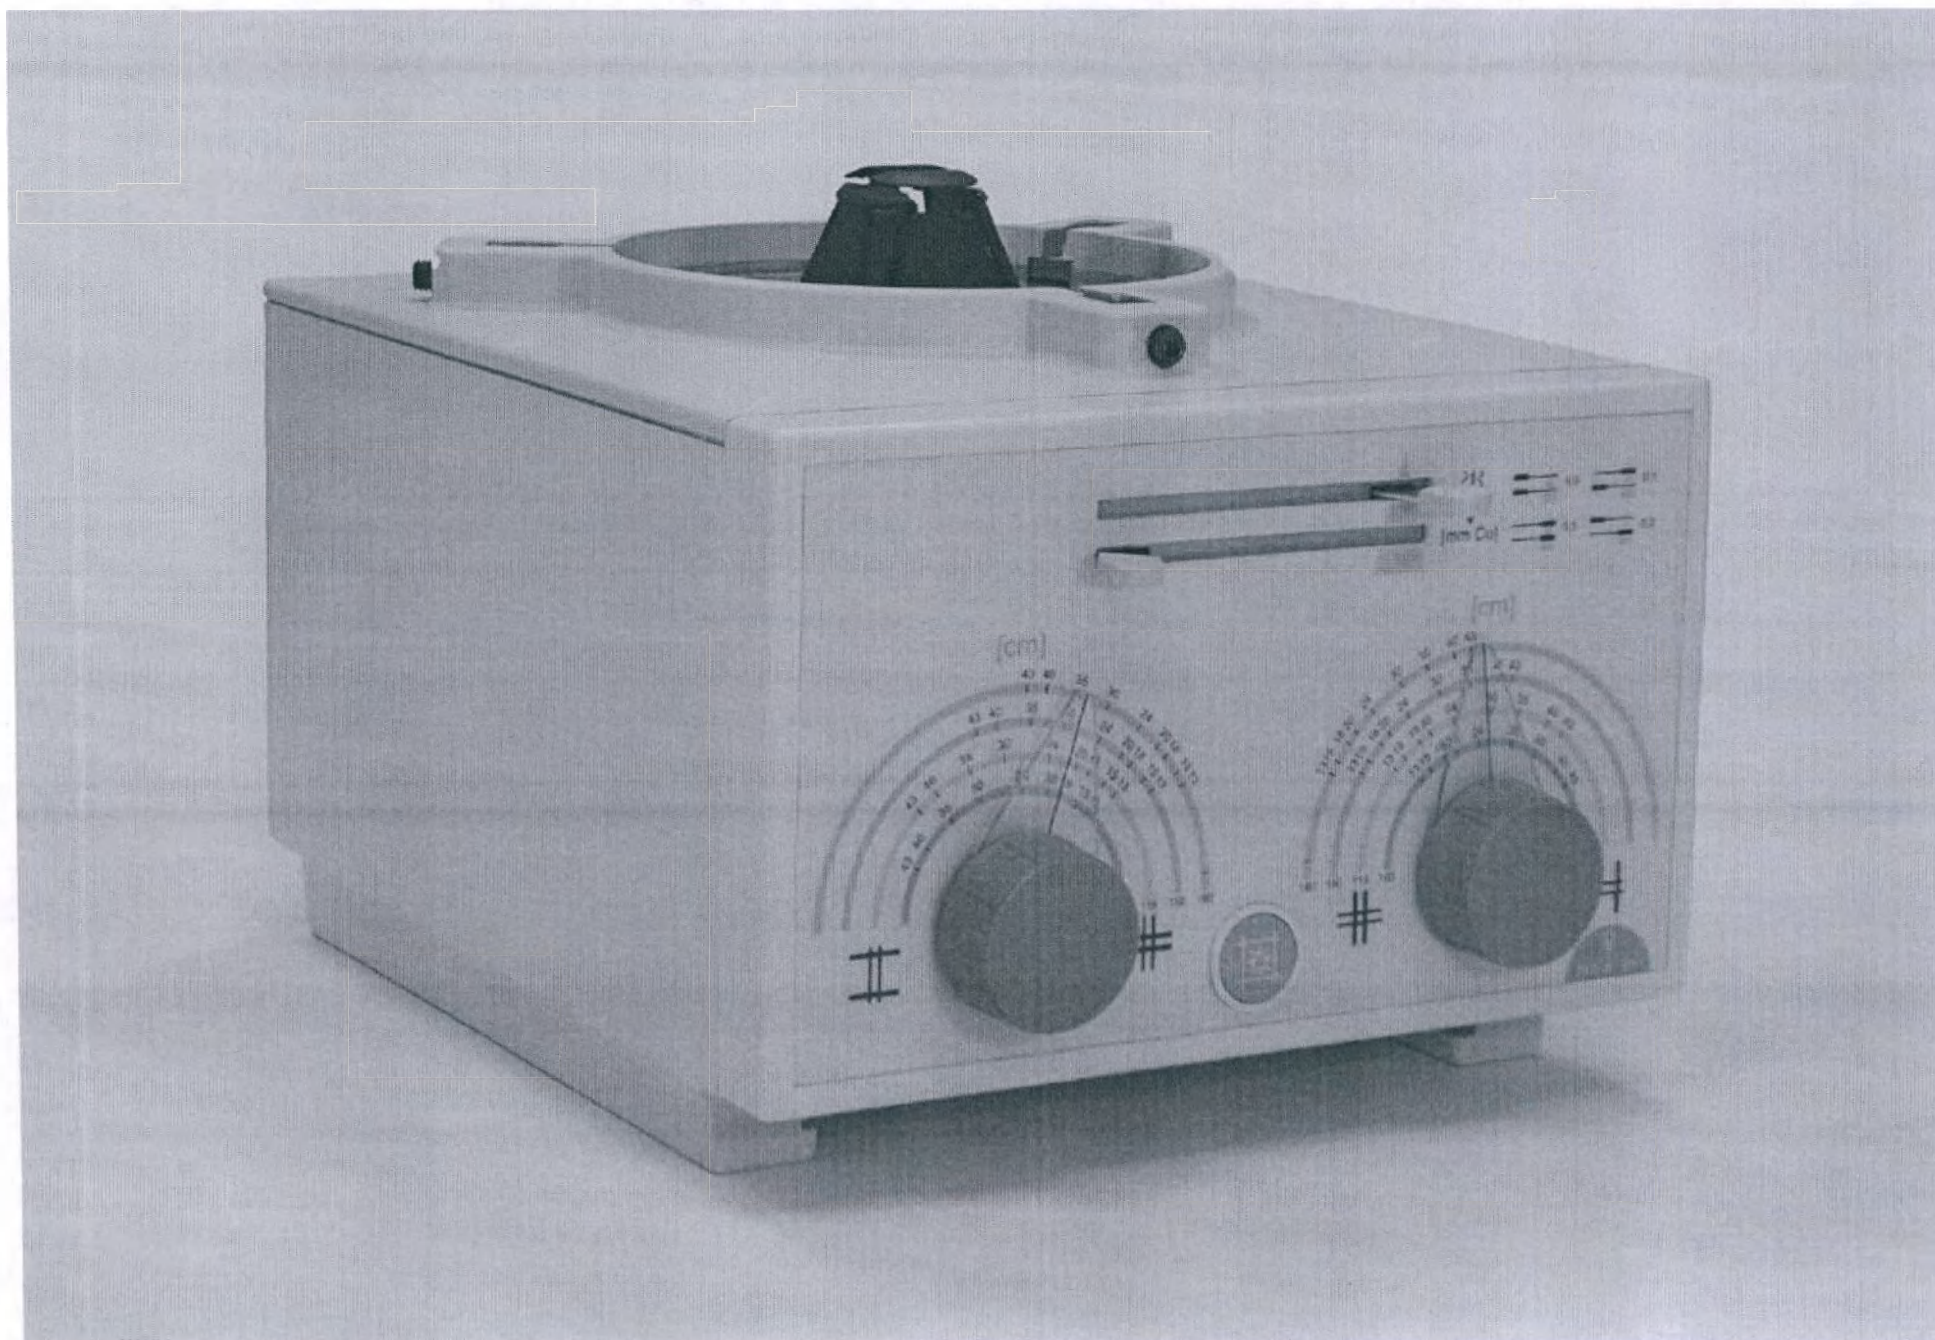


или Optica производства Varex Imaging Corporation, США.



6. Комплект эксплуатационной документации.


7. Монитор врача CCL; ME; CL; MS; CV; JD производства JVC KENWOOD Corporation, Япония;

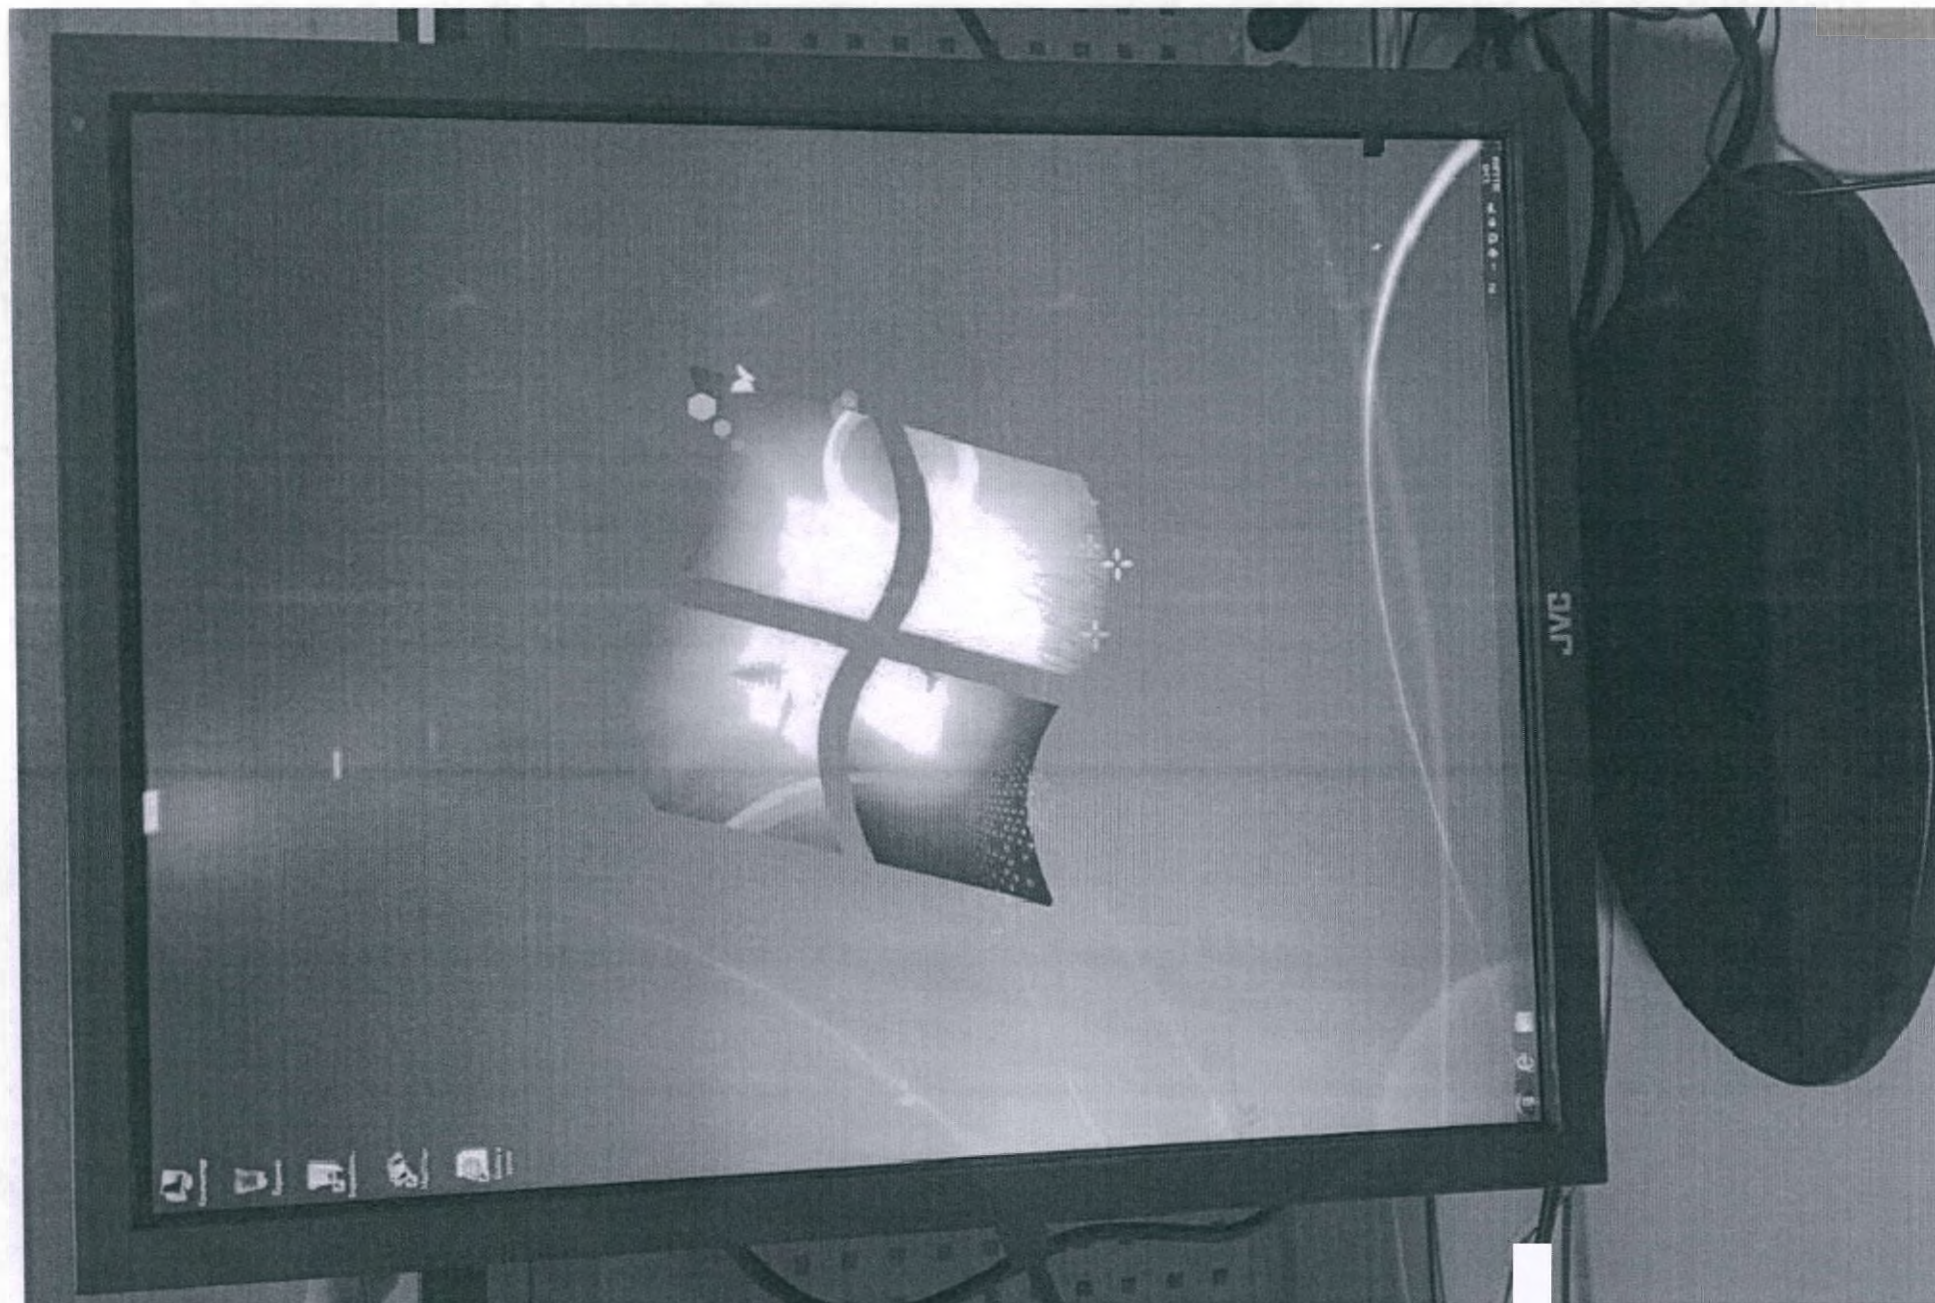

или NDS производства National Display Systems Inc., США;




или NL производства Nical SPA, Италия;

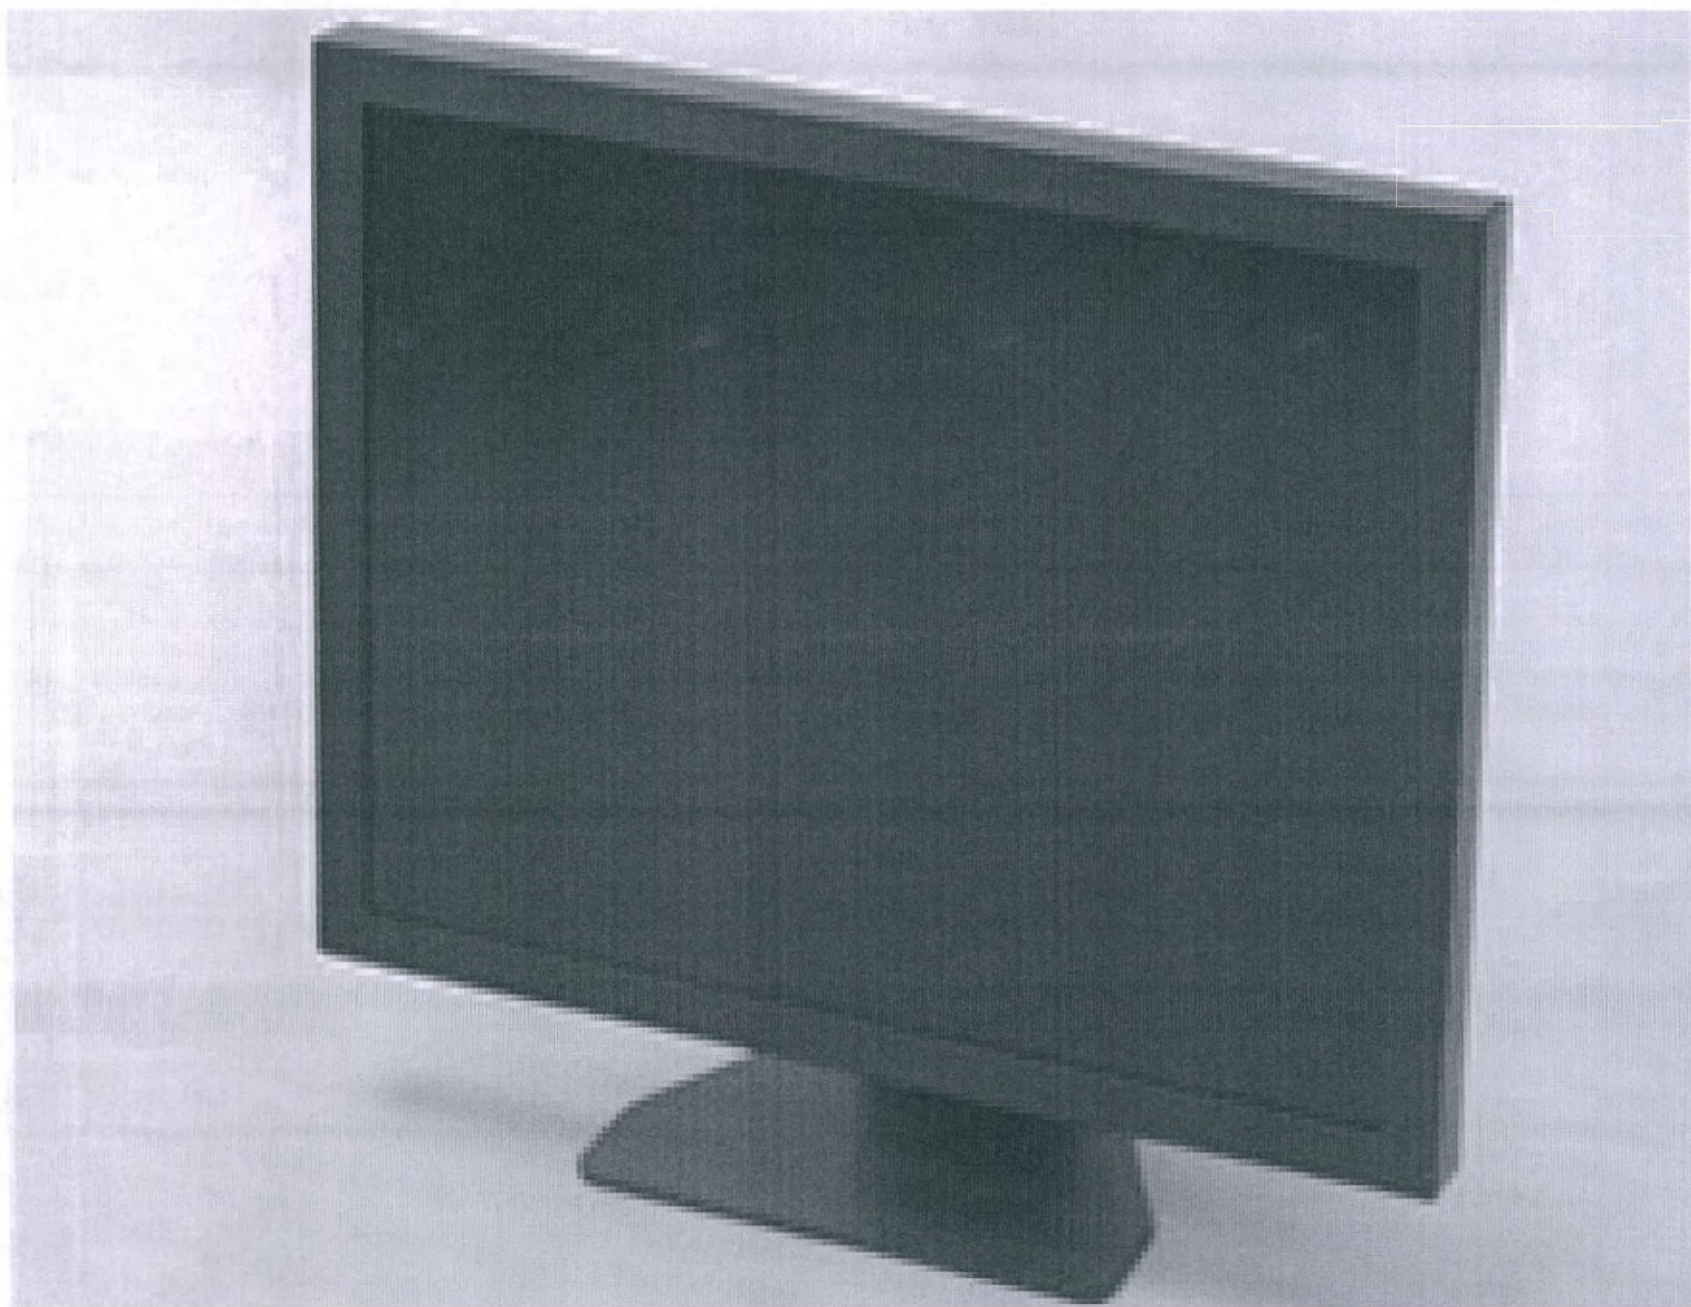


или N, MX, CX, CW производства Wide Corporation, Корея;




или FS; FM; MX производства Foreseeson GmbH, Канада;

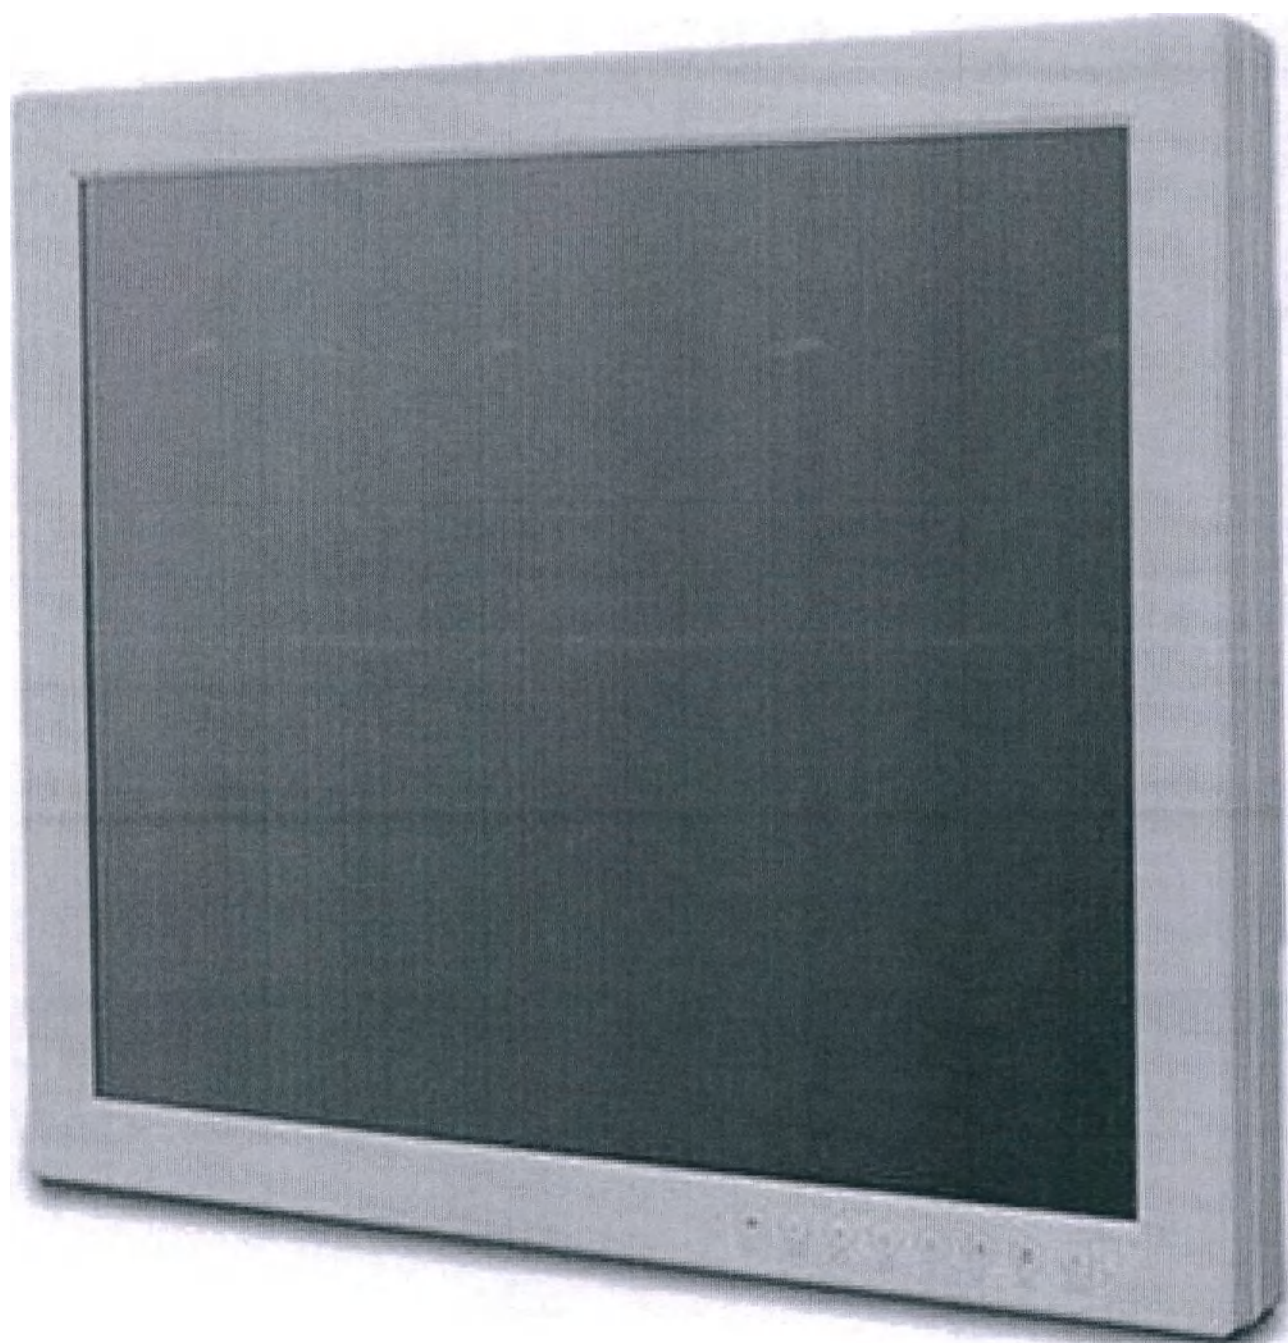

или NEC производства NEC Display Solutions, Япония;

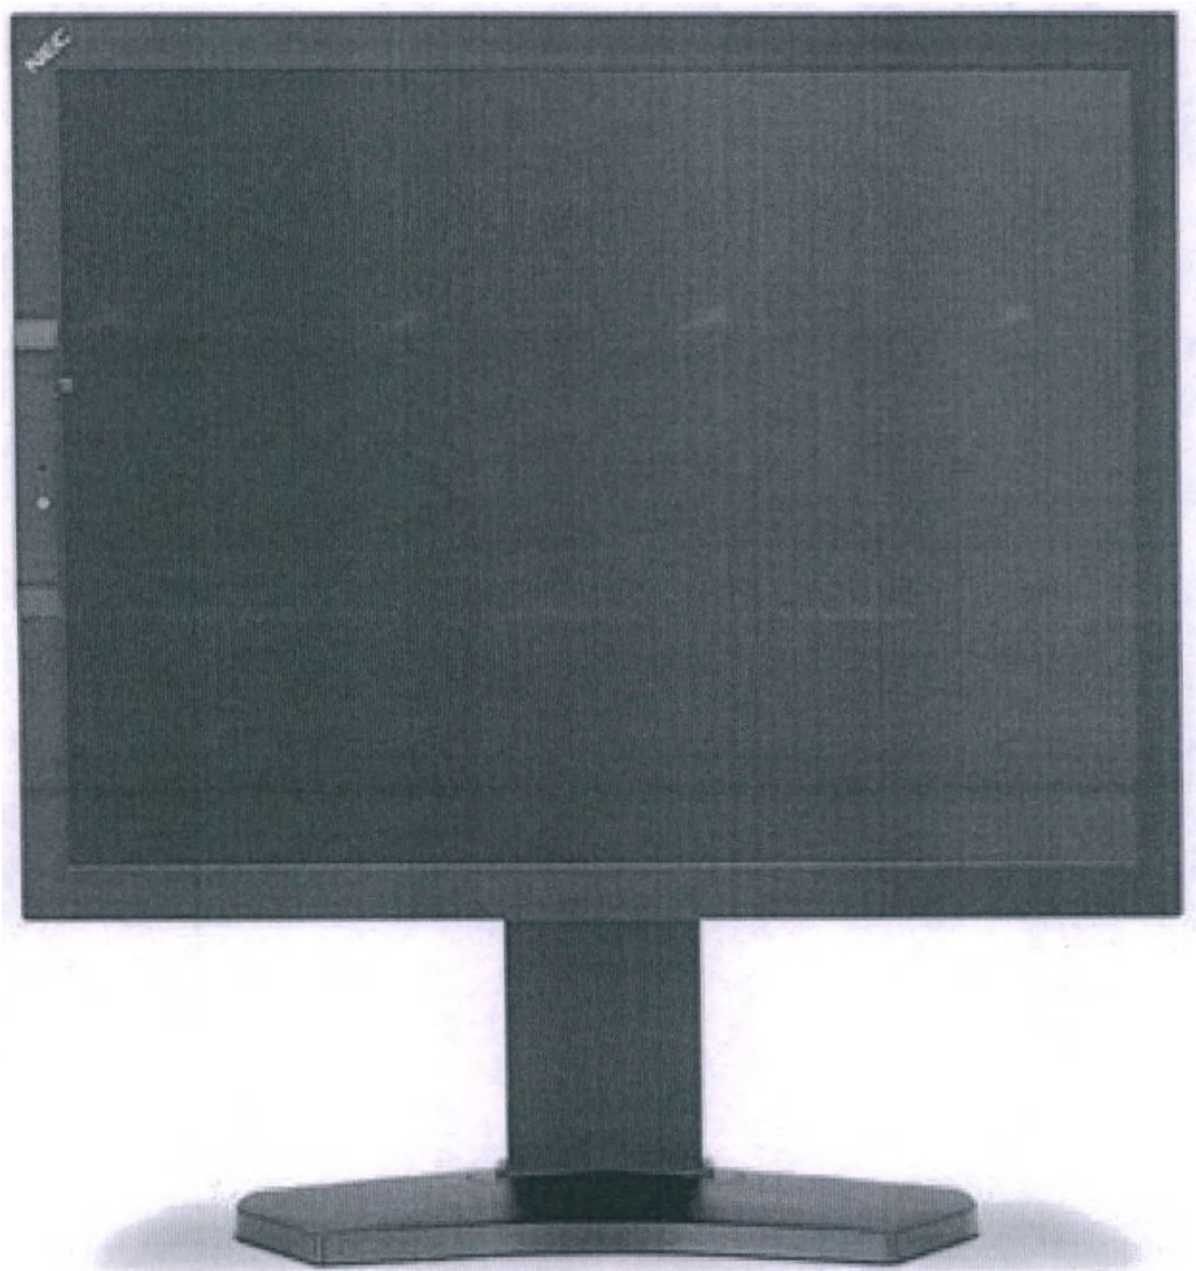


или G, С производства Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай;

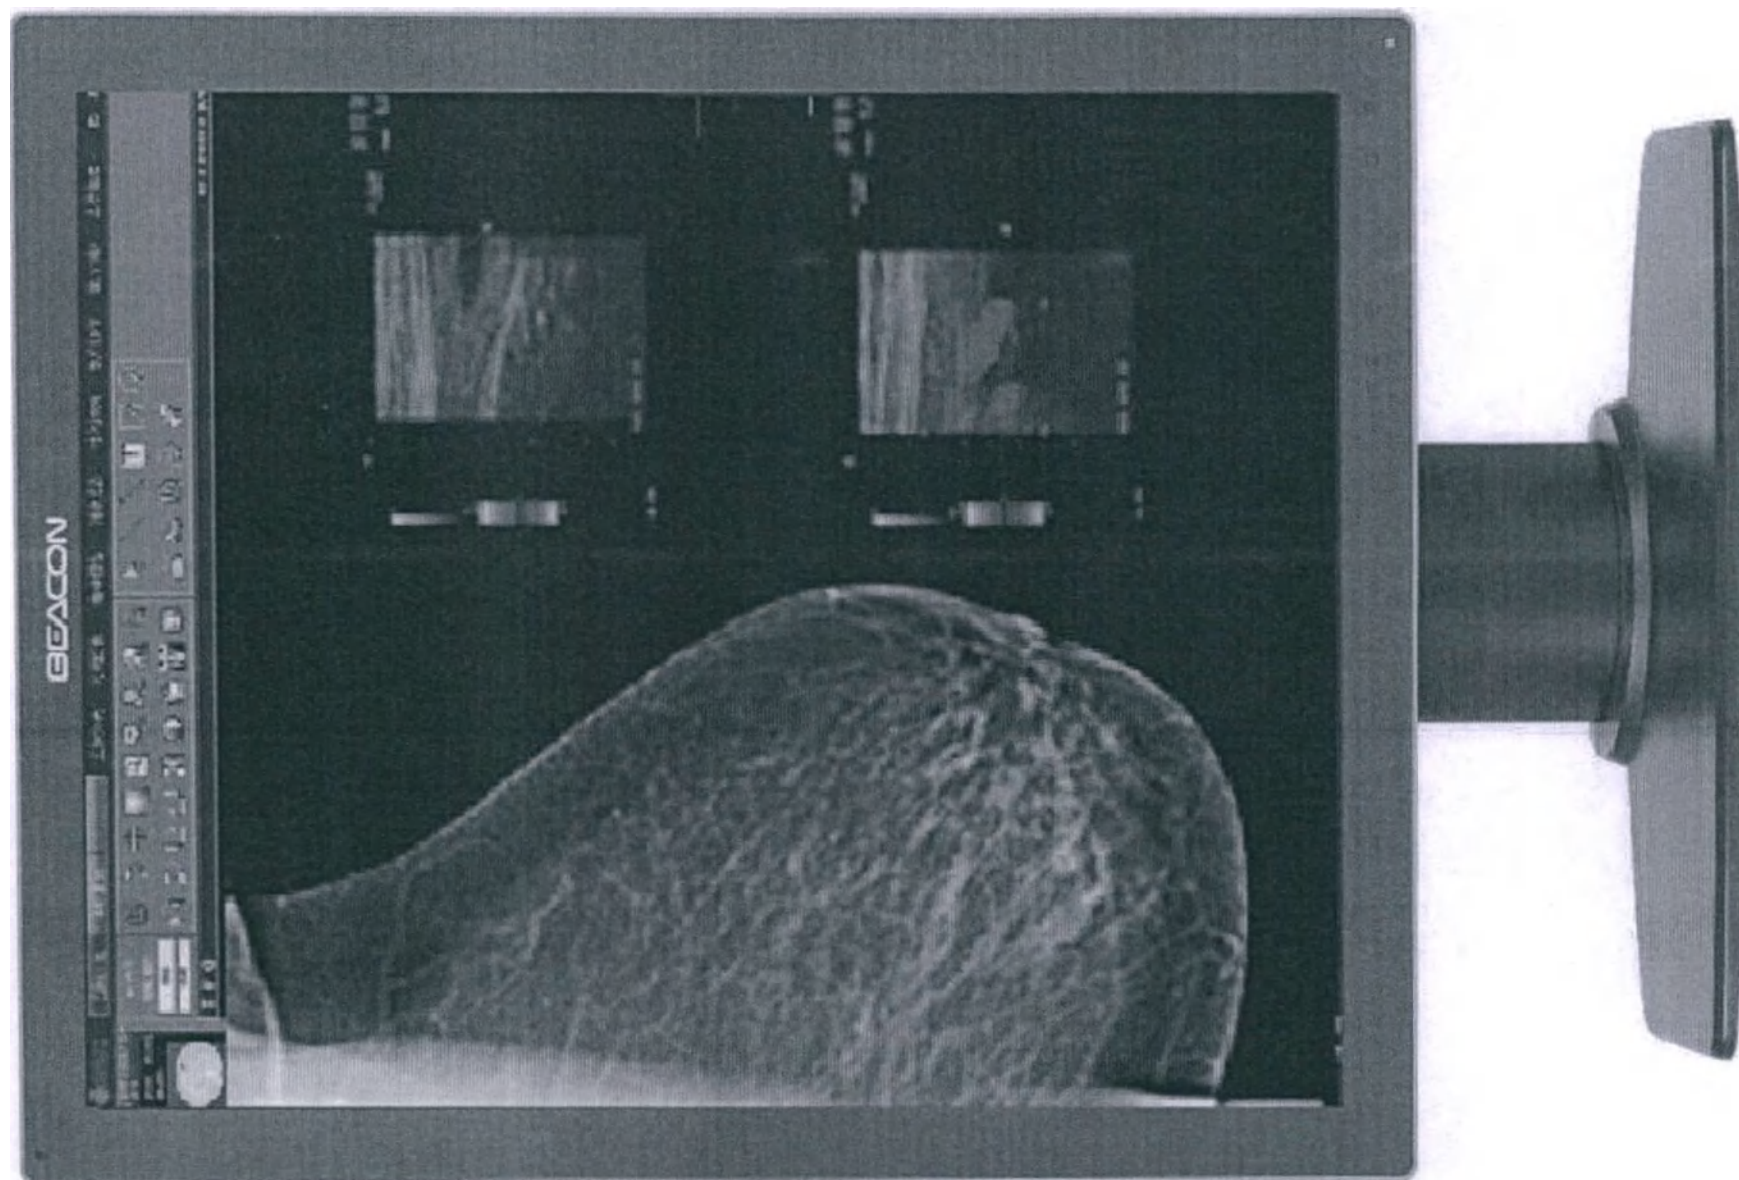


или MD производства BARCO N.V., Бельгия.




8. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 производства ООО НПП «Доза», Российская Федерация (РУ № РЗН 2014/1562);

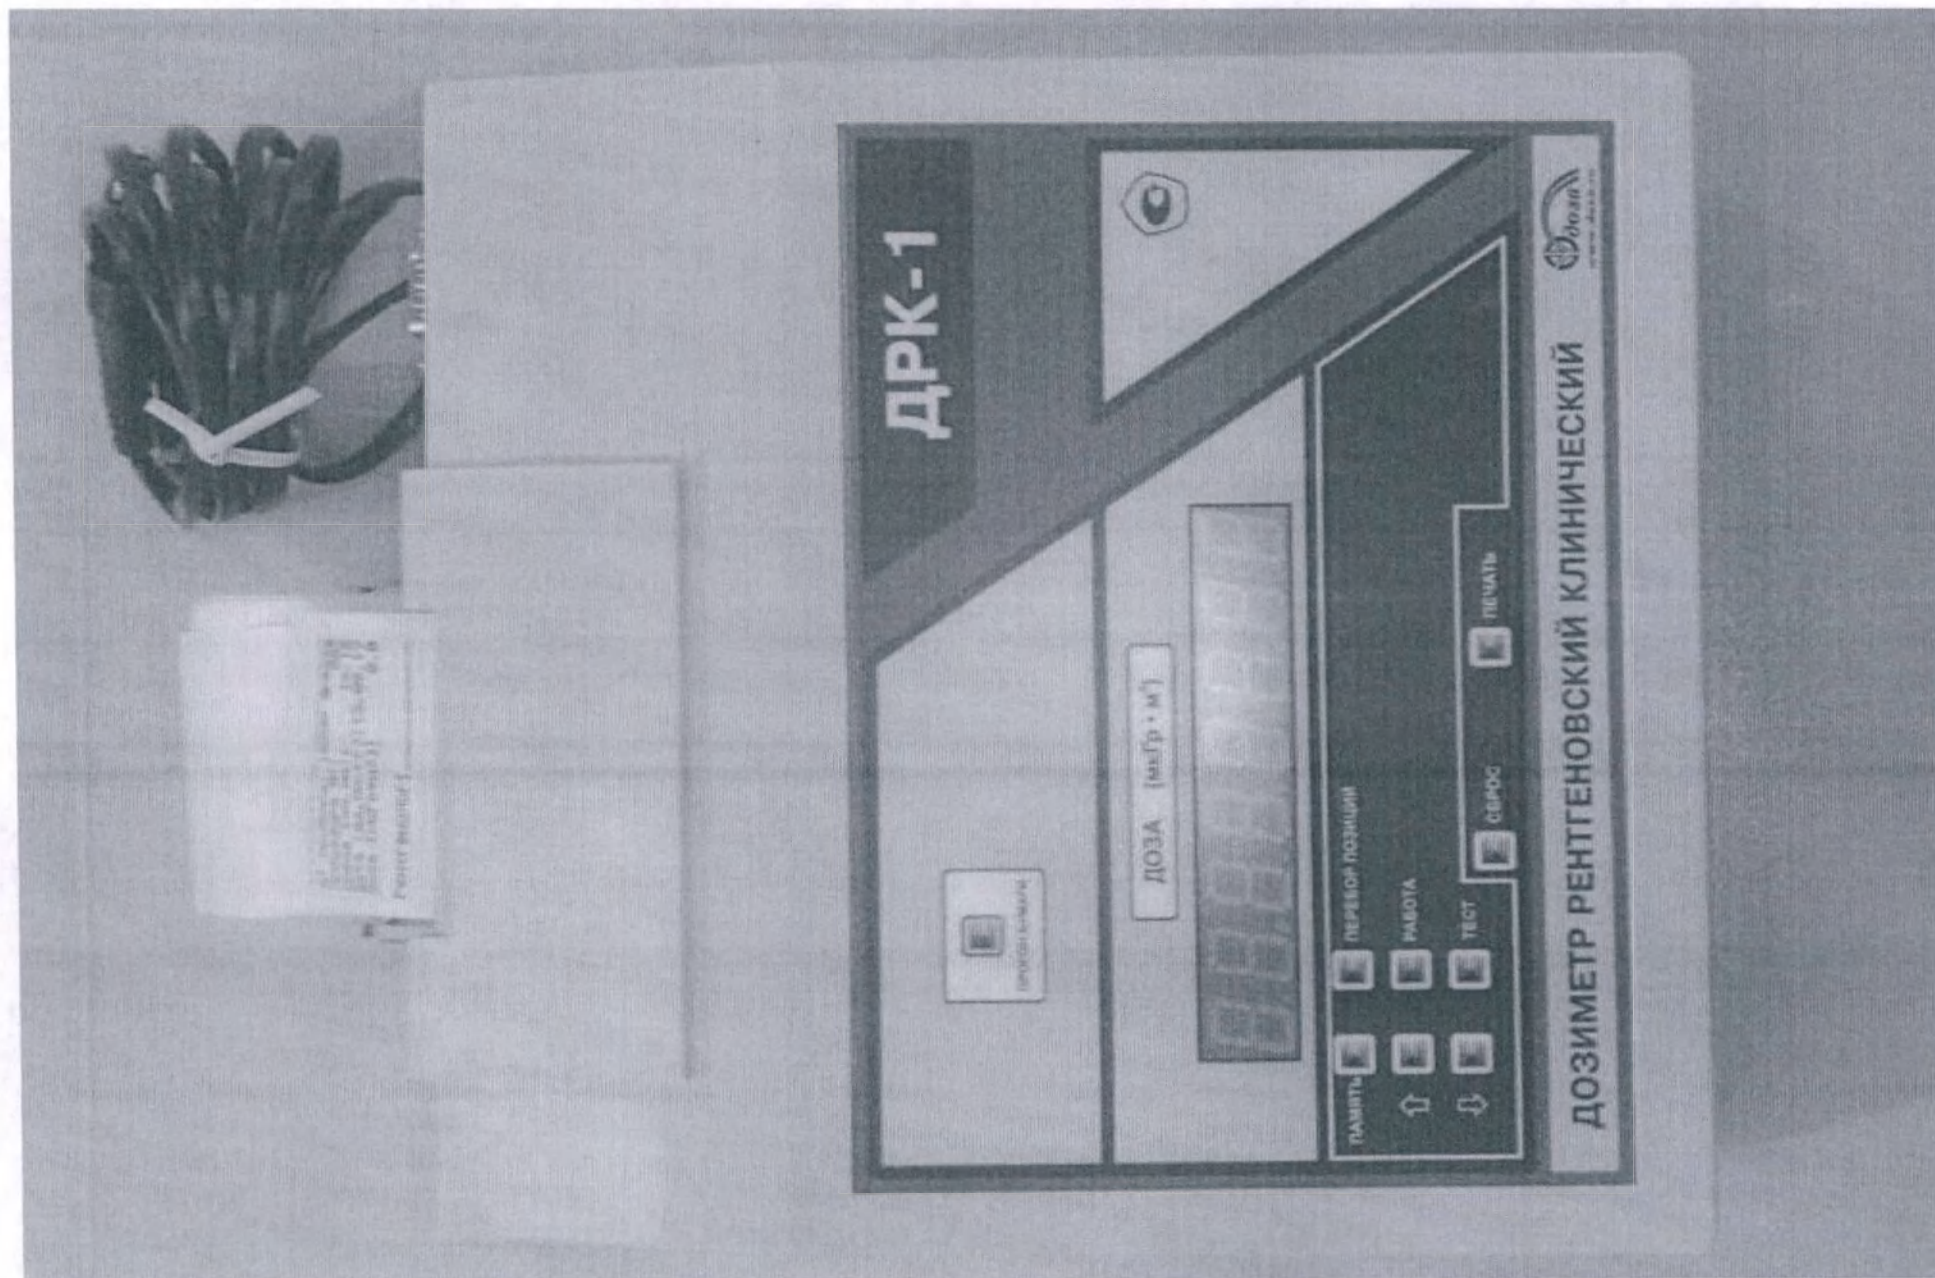


или дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия (РУ № ФСЗ 2012/11816);

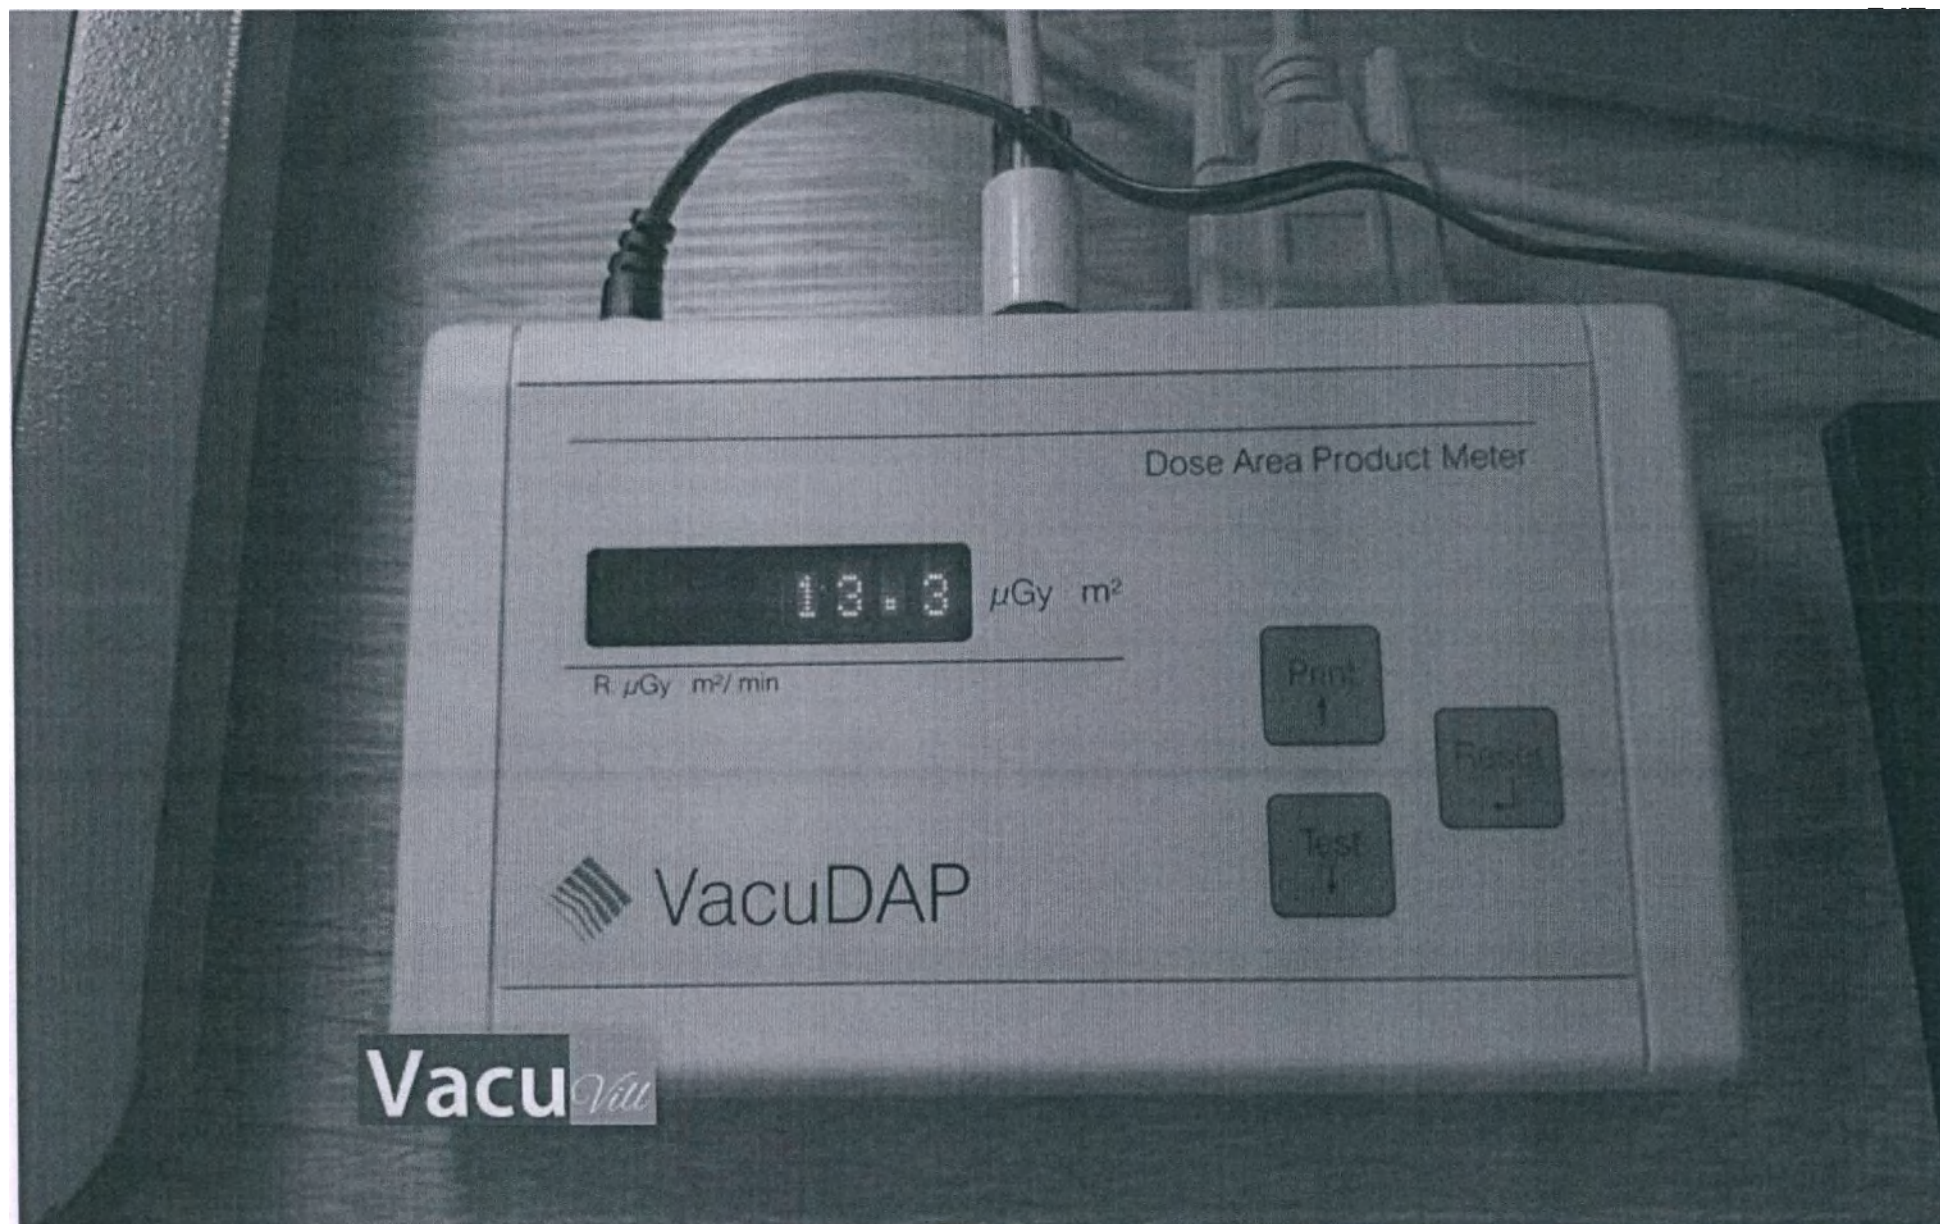


или Кермах производства IBA Dosimetry GmbH, Германия.

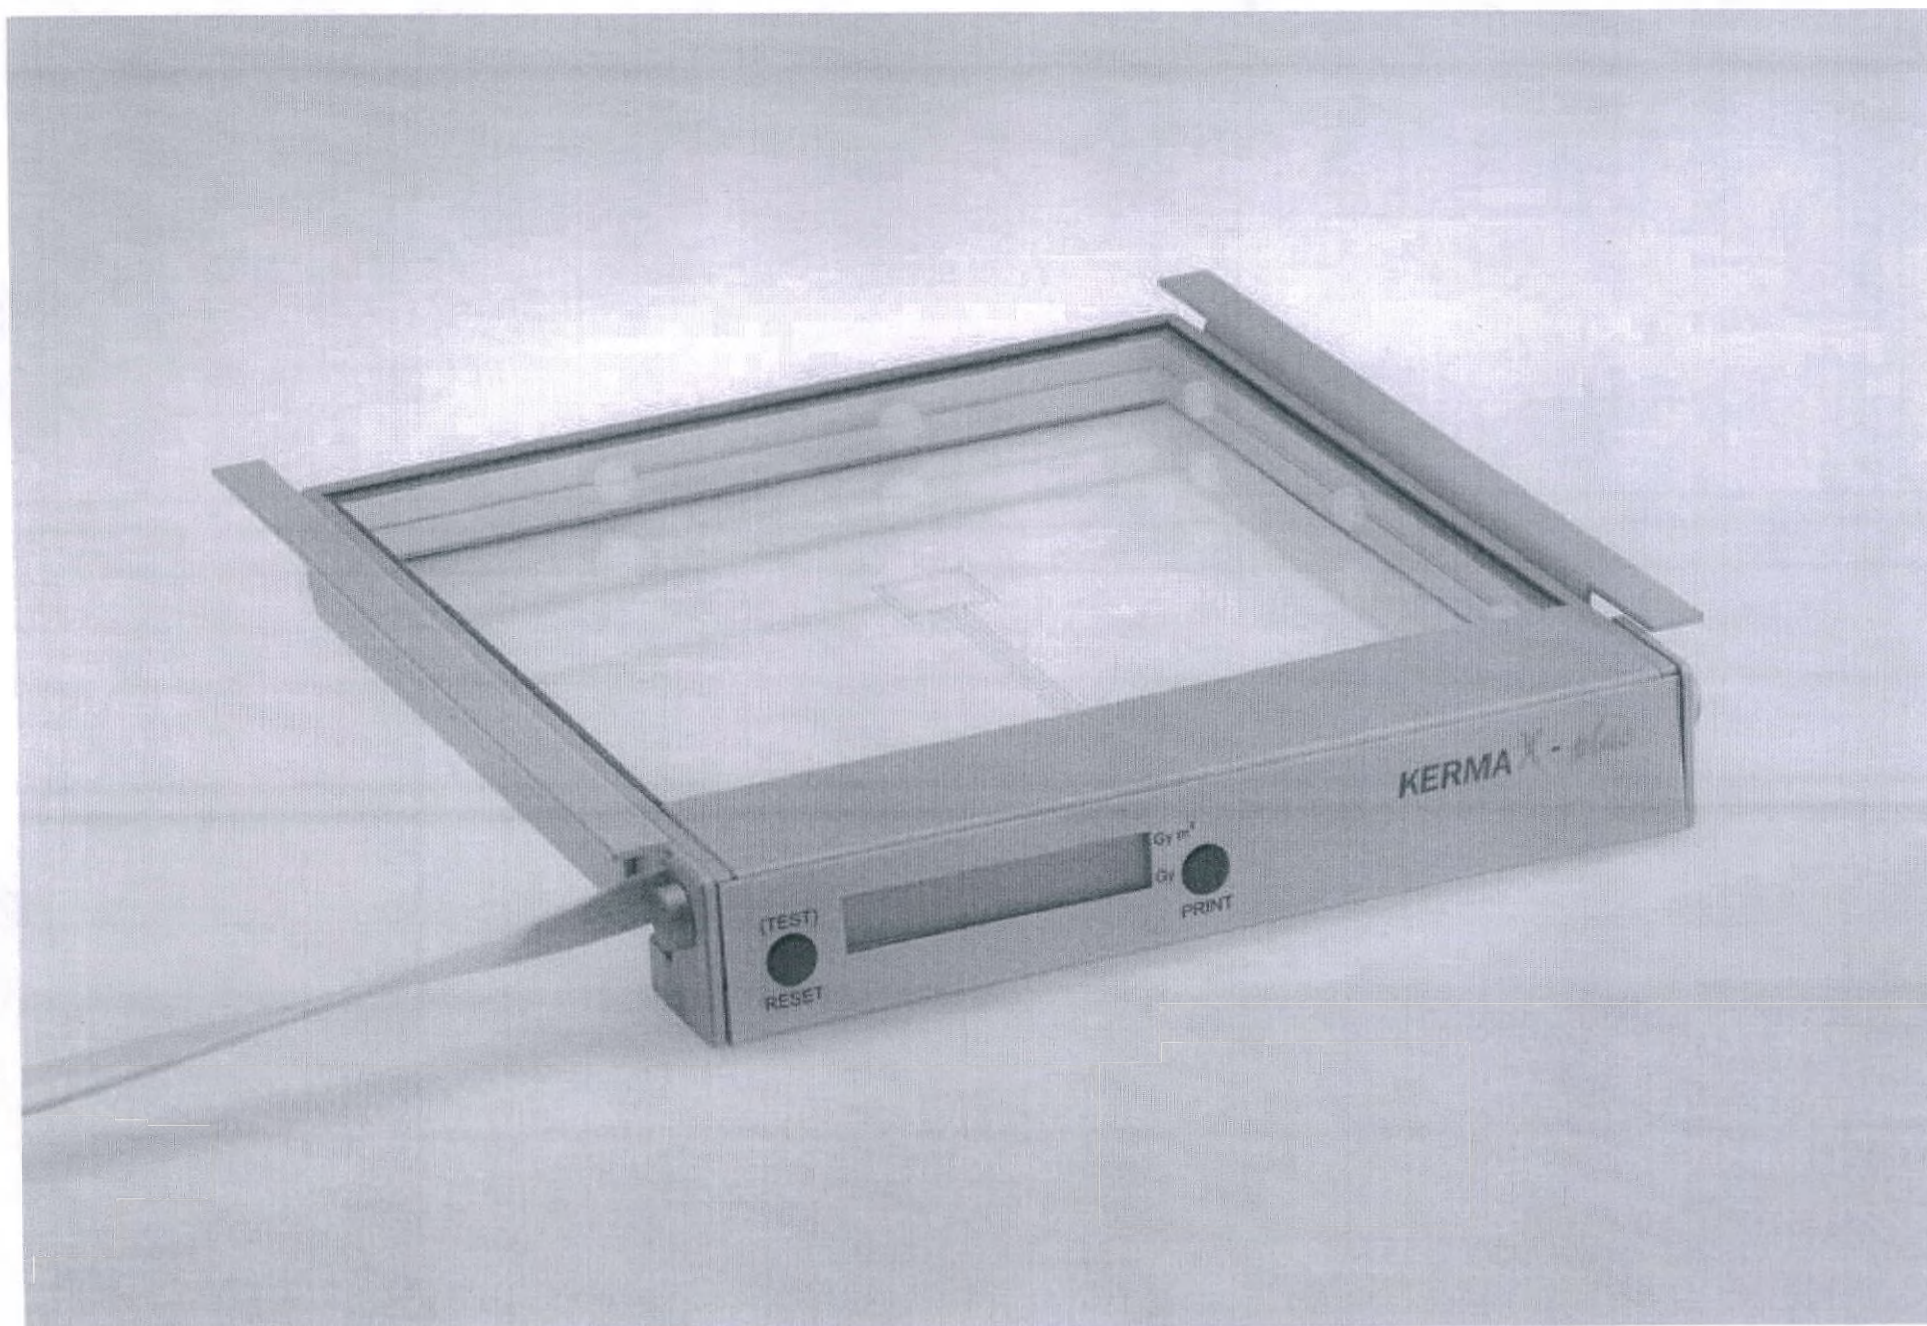

9. Комплект кассет, производства ЗАО «Ренекс», Российская Федерация.

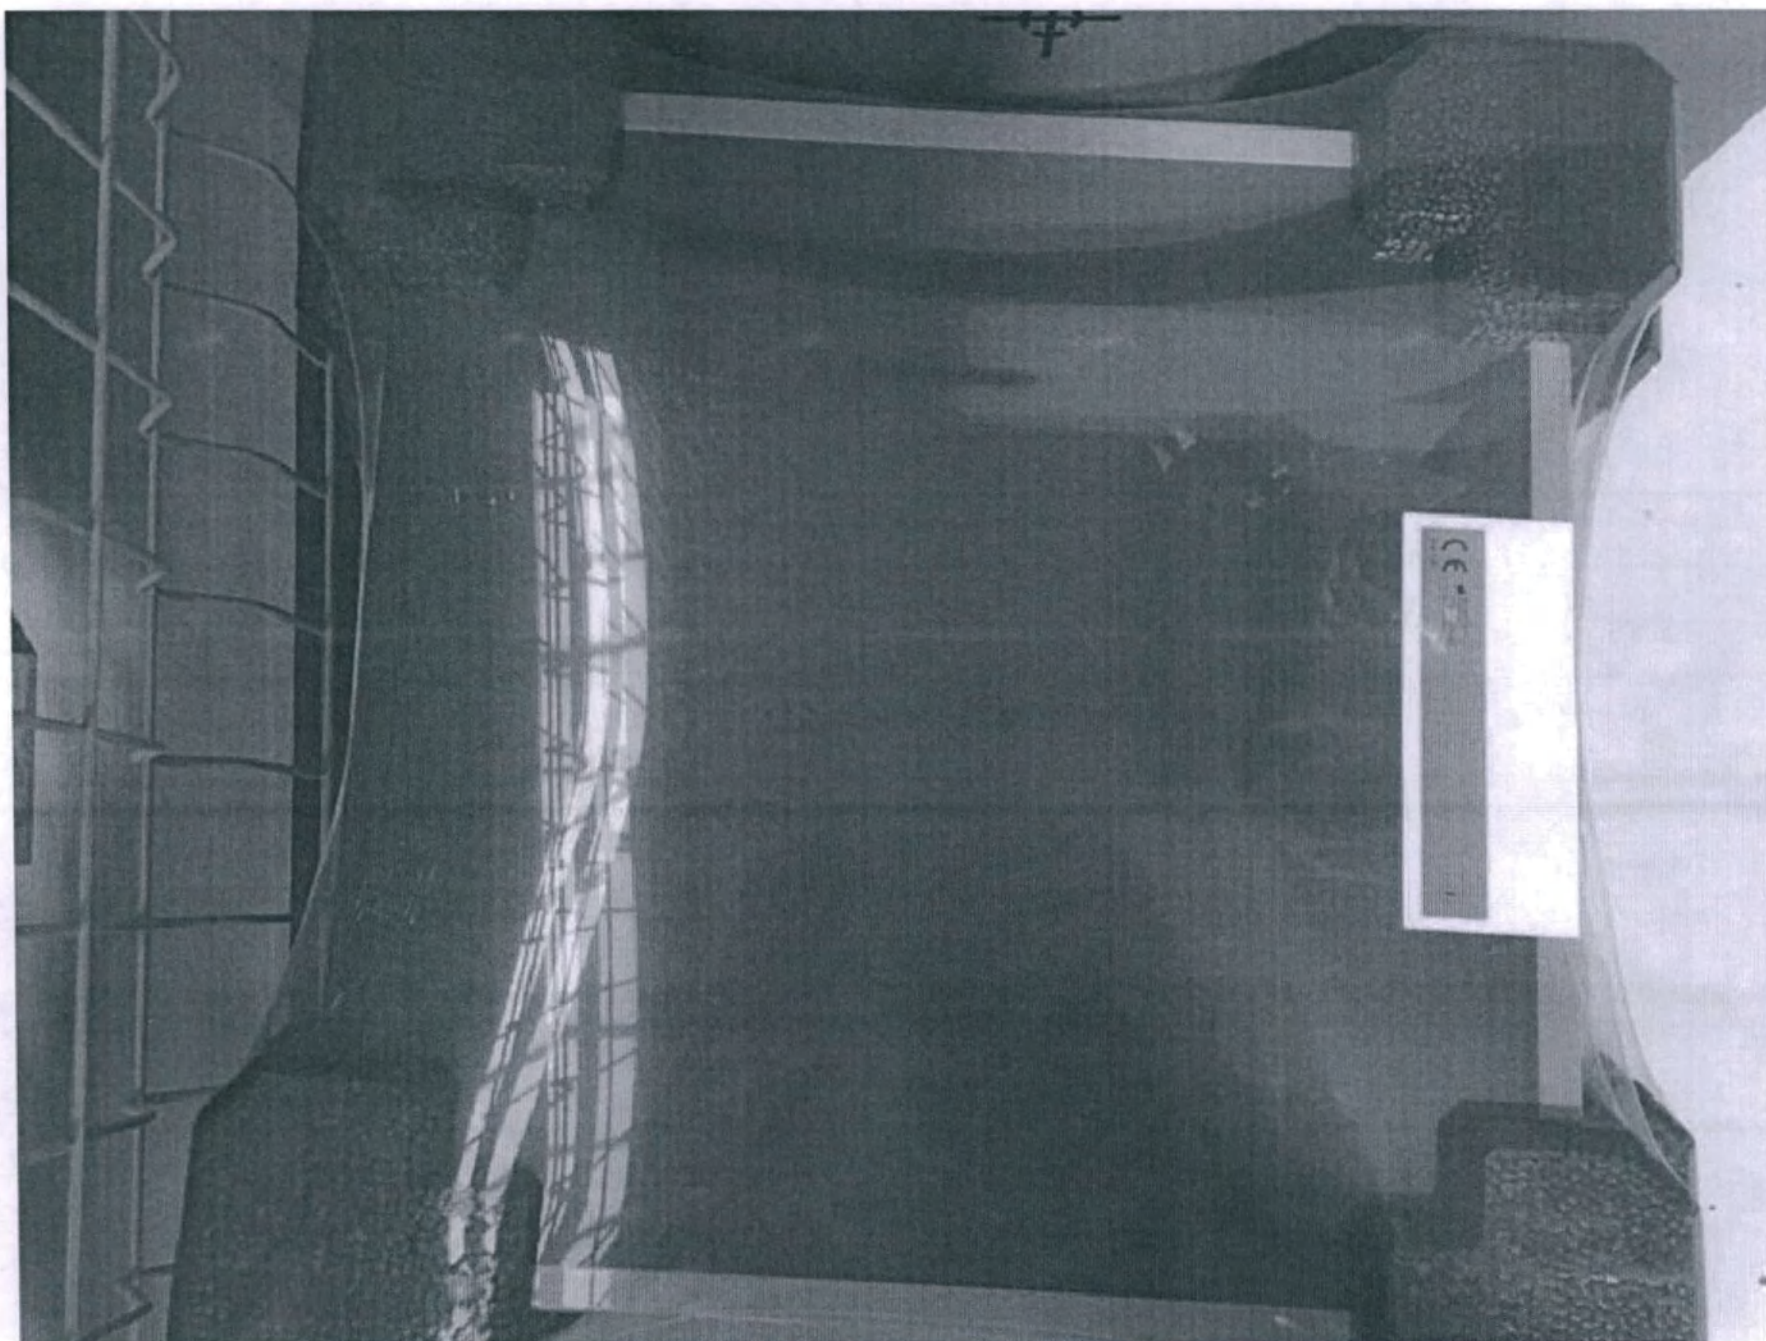


10. Комплекс цифровой CR диагностический для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений (CR 30-Xm или CR 10-X) (ПУ № РЗН 2015/2731); или система компьютерной рентгенографии CR (CR 12-X или CR 15-X) (ПУ № РЗН 2015/3346); или комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений (DX-M или DX-G) (ПУ № ФСЗ 2011/09003) производства Agfa N.V., Бельгия;

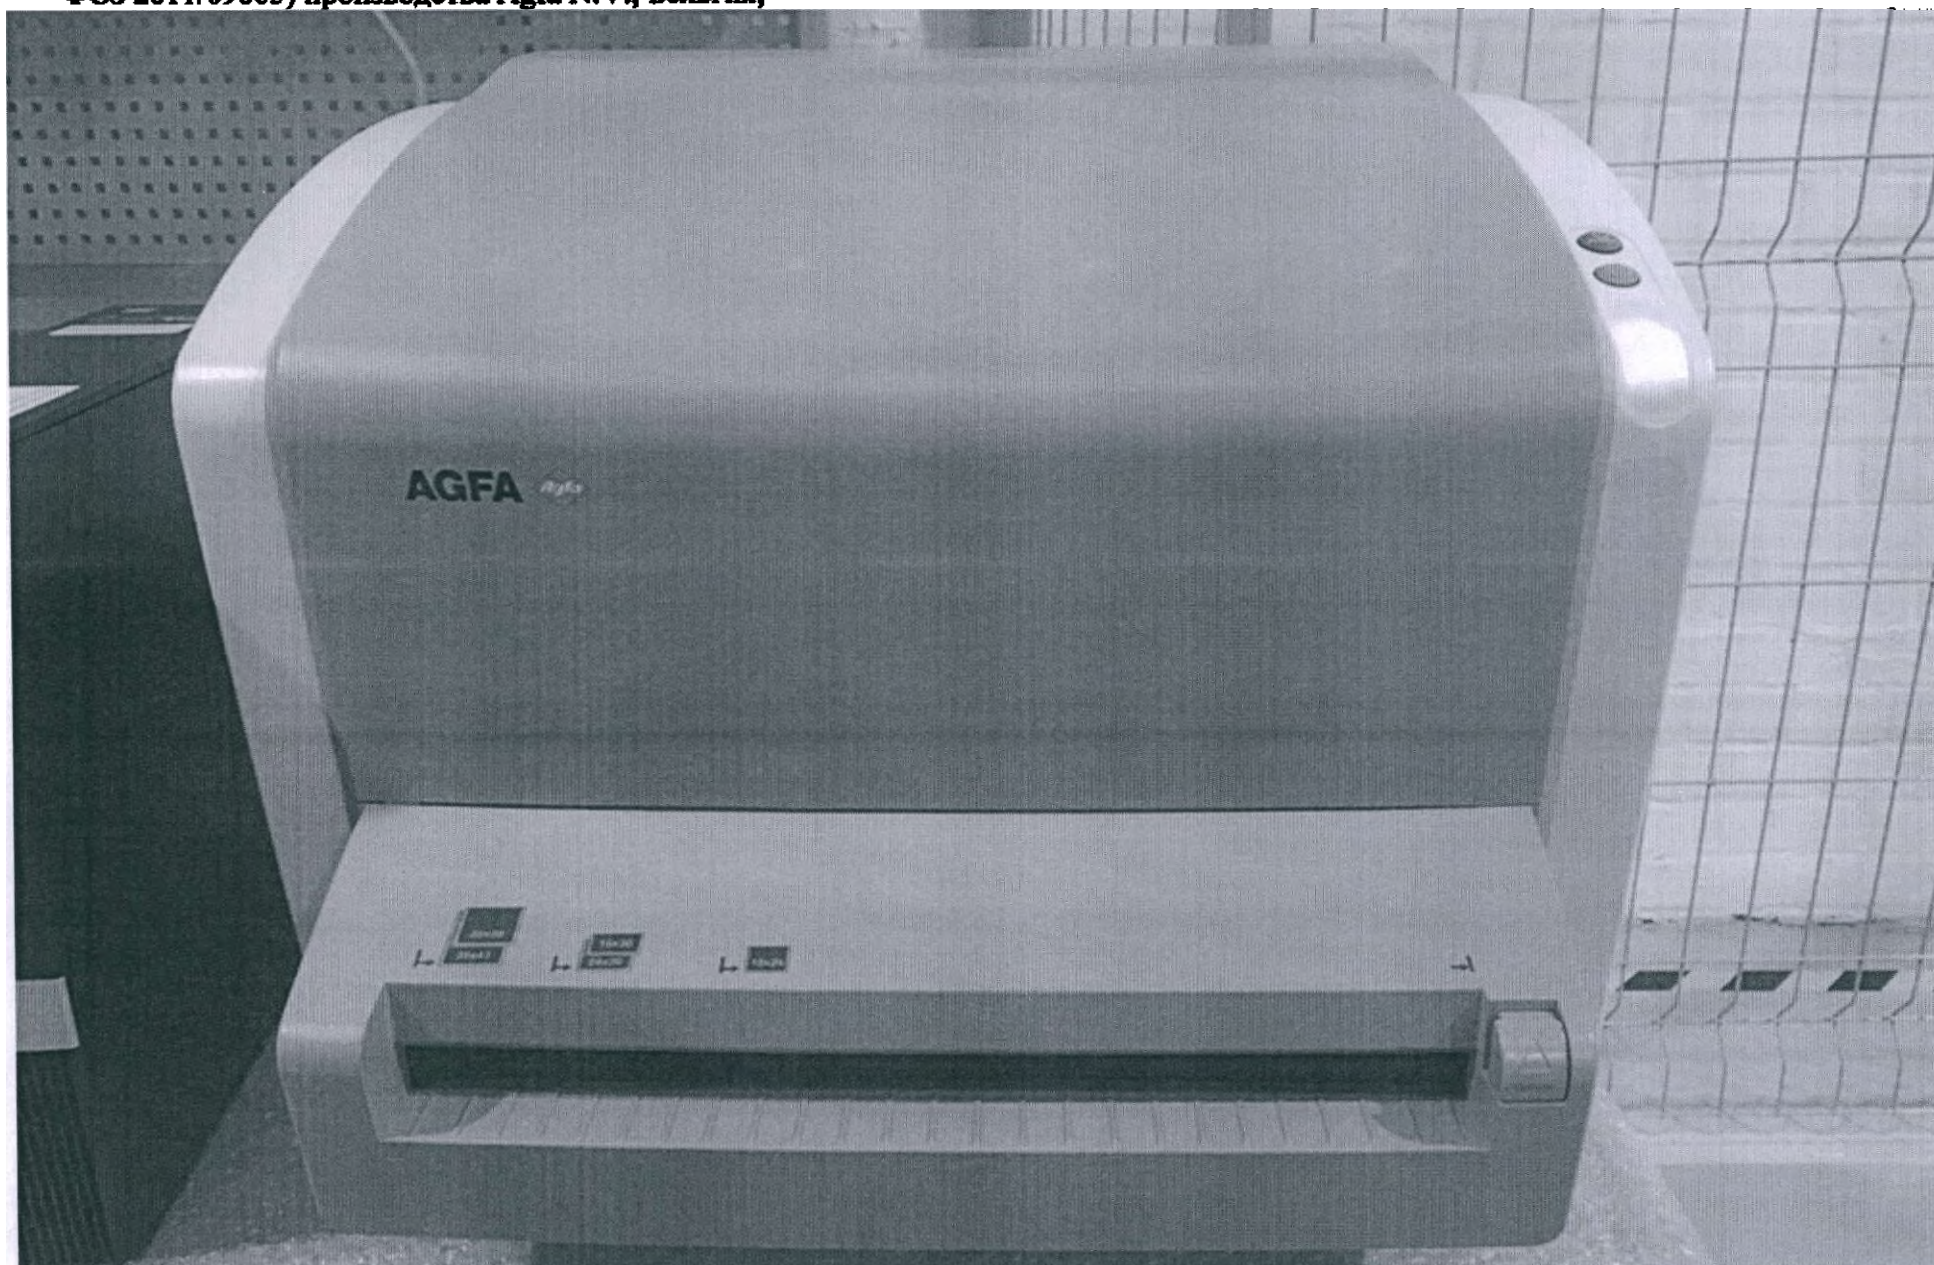

или система компьютерной радиологии REGIUS 110 (ПУ № ФСЗ 2010/06650) или REGIUS 210 (ПУ № ФСЗ 2010/06649) или REGIUS SIGMA (ФСЗ 2011/10738) производства Konica Minolta Medical&Graphic, Inc., Япония;



или система цифровой радиографии Vita Flex CR System (РУ № РЗН 2017/5376) или Vita XE или серии CR System исполнения: Classic, Elite (РУ № ФСЗ 2010/08204) производства Carestream Health Inc., США;

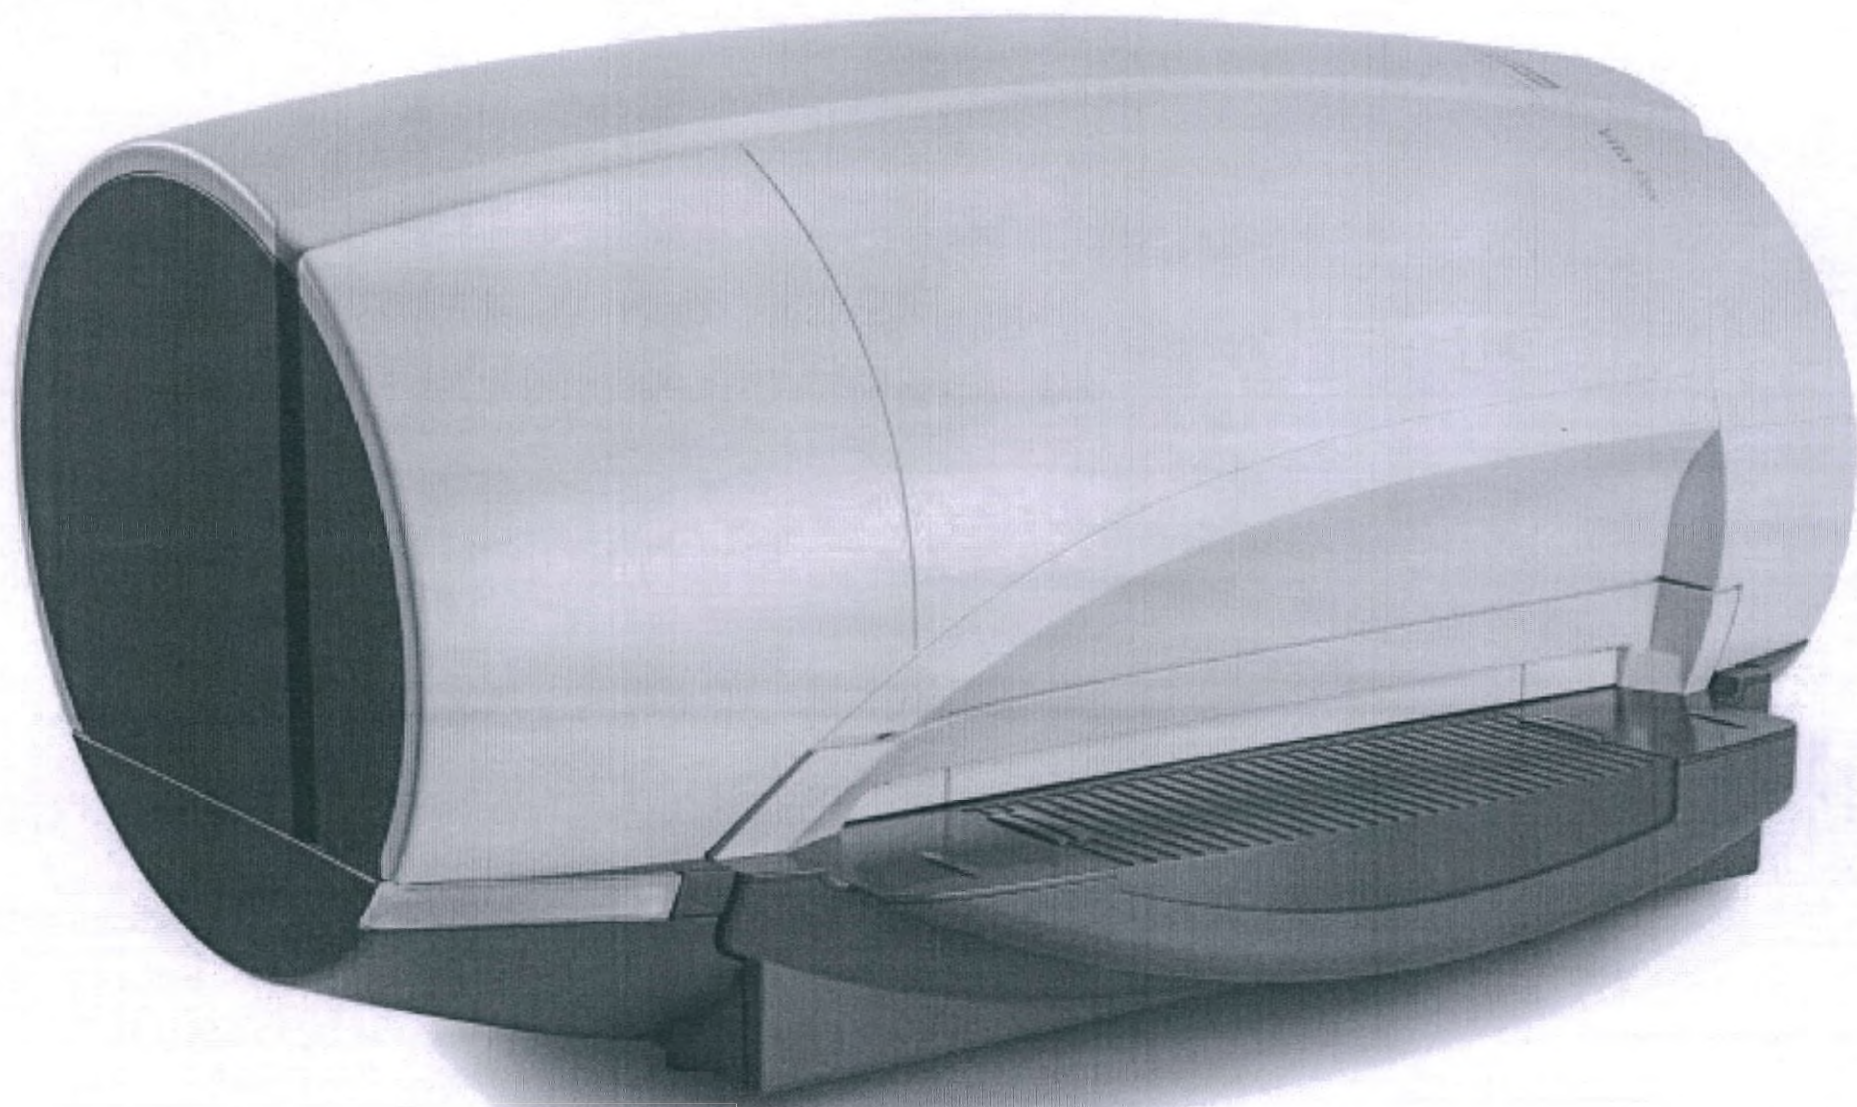

или Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров, модели: FCR Capsula X (CR-IR 357), FCR Capsula XL (CR-IR 356), FCR Profect One (CR-IR 368), FCR XG1 (CR-IR 346), FCR XG5000 (CR-IR 362), FCR Profect CS (CR-IR 363) (ПУ № ФСЗ 2007/00091) или FCR Prima T (CR-IR 392) (ПУ № РЗН 2013/910) или устройство для цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров FCR Capsula XL2 (CR-IR 359) (ПУ № ФСЗ 2009/04740) или FCR PROPECT CS Plus производства Fujifilm Corporation, Япония;




или CR 3600 или CR Chrome производства iCRco Inc., США;



или аппарат компьютерной радиологии FireCR Spark производства 3D Imaging & Simulations Corp. (3DISC), США (РУ № РЗН 2018/7751).



11. АРМ врача-рентгенолога производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

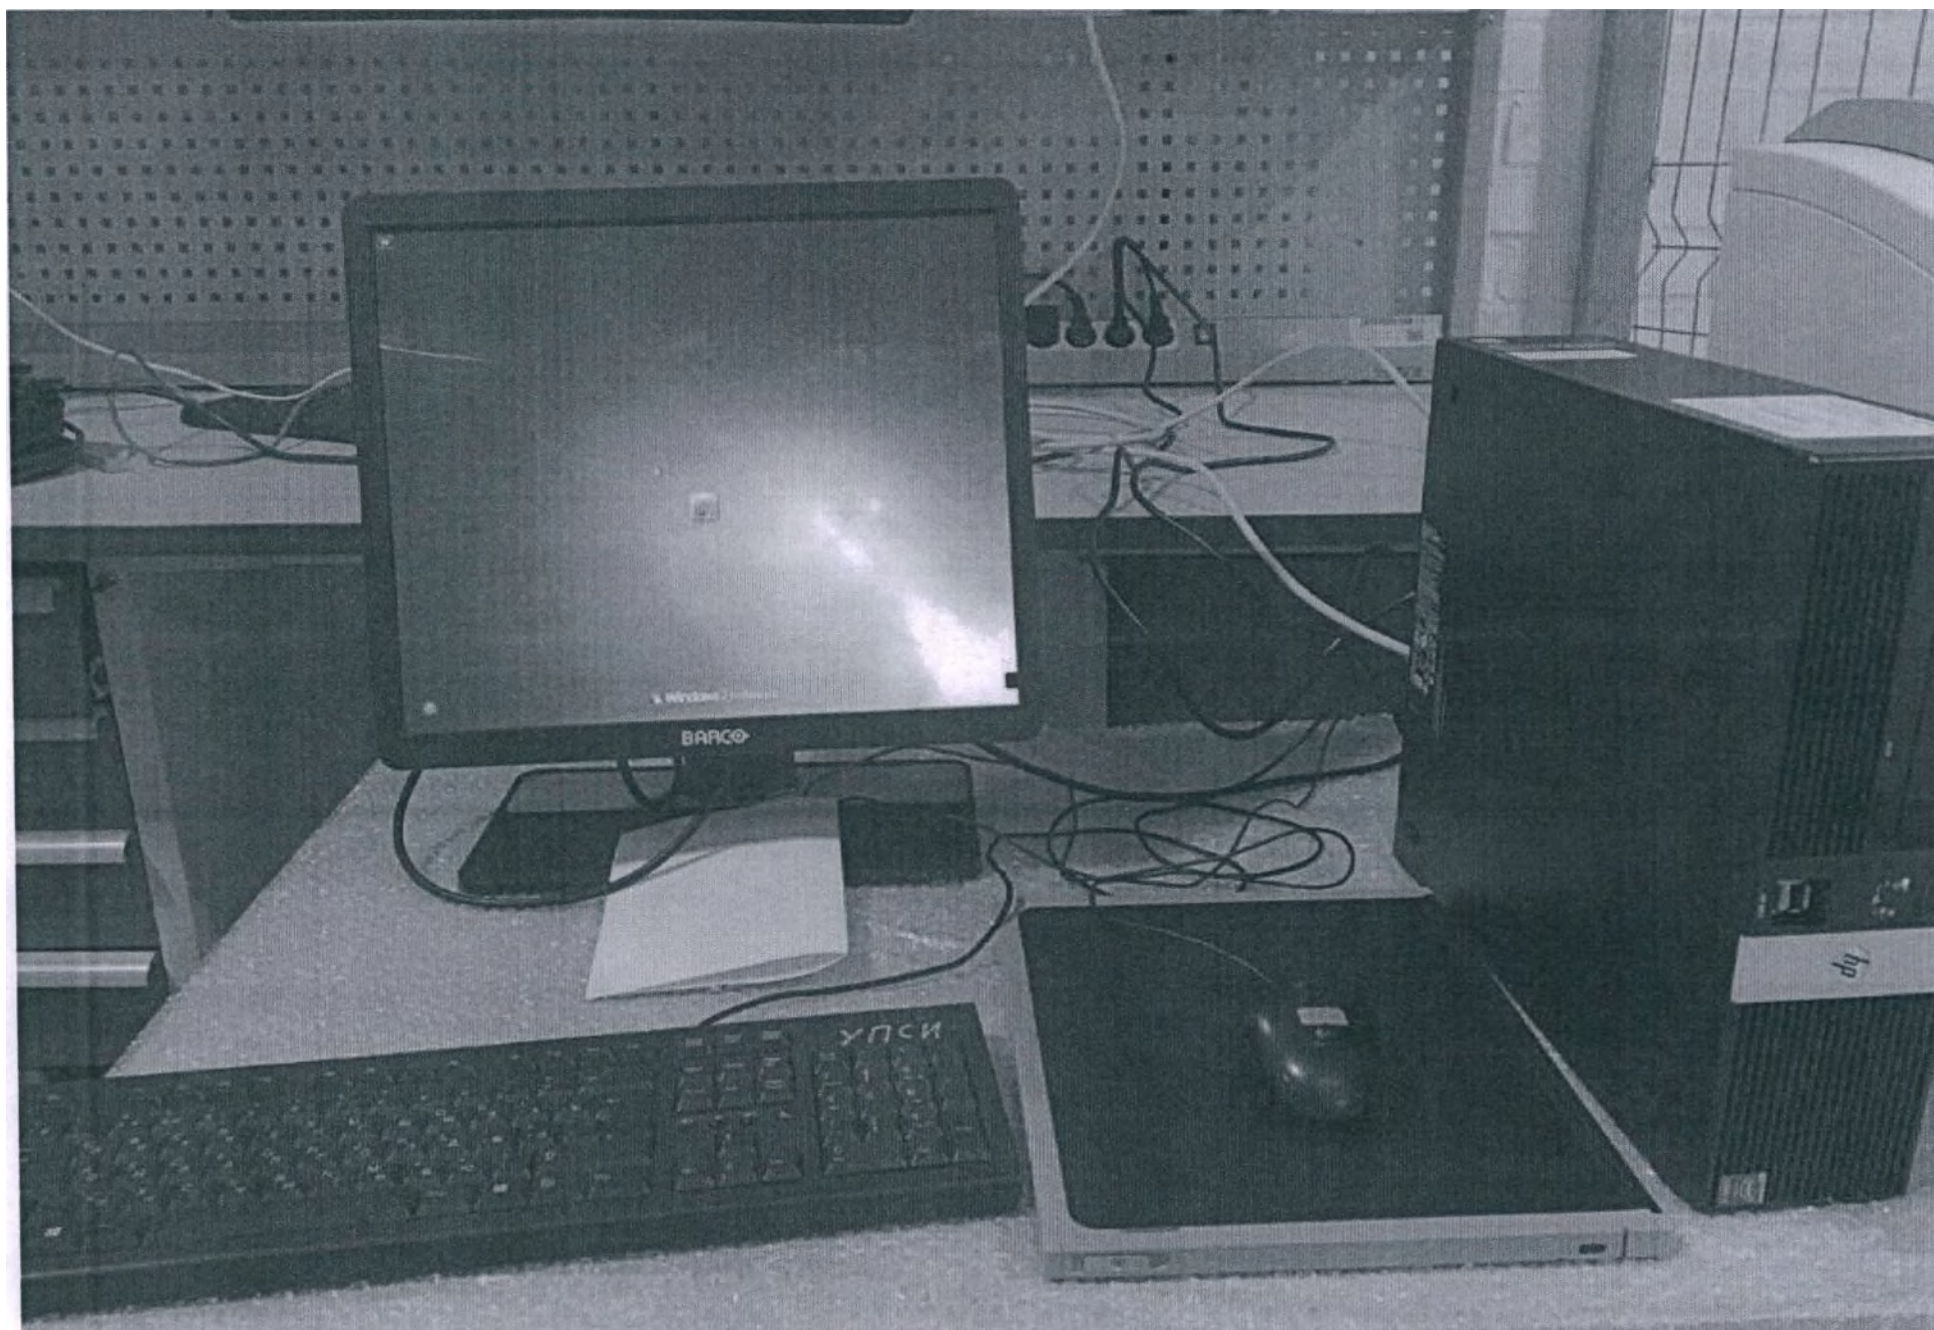

или комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007 производства ООО «МЕД-РЕЙ», Россия (РУ № ФСР 2008/02715).



12. Камера мультиматная термографическая Drystar Axys или Drystar 5302 (ПУ № ФСЗ 2008/02792) или Drystar 5503 производства Agfa N.V., Бельгия;




или камера медицинская термографическая мультиформатная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite (ПУ № РЗН 2013/911) или камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX 4000 исполнения DRYPIX Plus (ПУ № ФСЗ 2012/12949) производства Fujifilm Corporation, Япония;




или камера лазерная мультимедийная TRIMAX TX55 Laser Imaging System (ПУ № РЗН 2016/4667) или камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений (ПУ № ФСЗ 2011/10352) производства Carestream Health, Inc., США;



или устройство для печати монохромных медицинских изображений UP производства Sony Corporation, Япония (РУ ФСЗ 2011/10354).

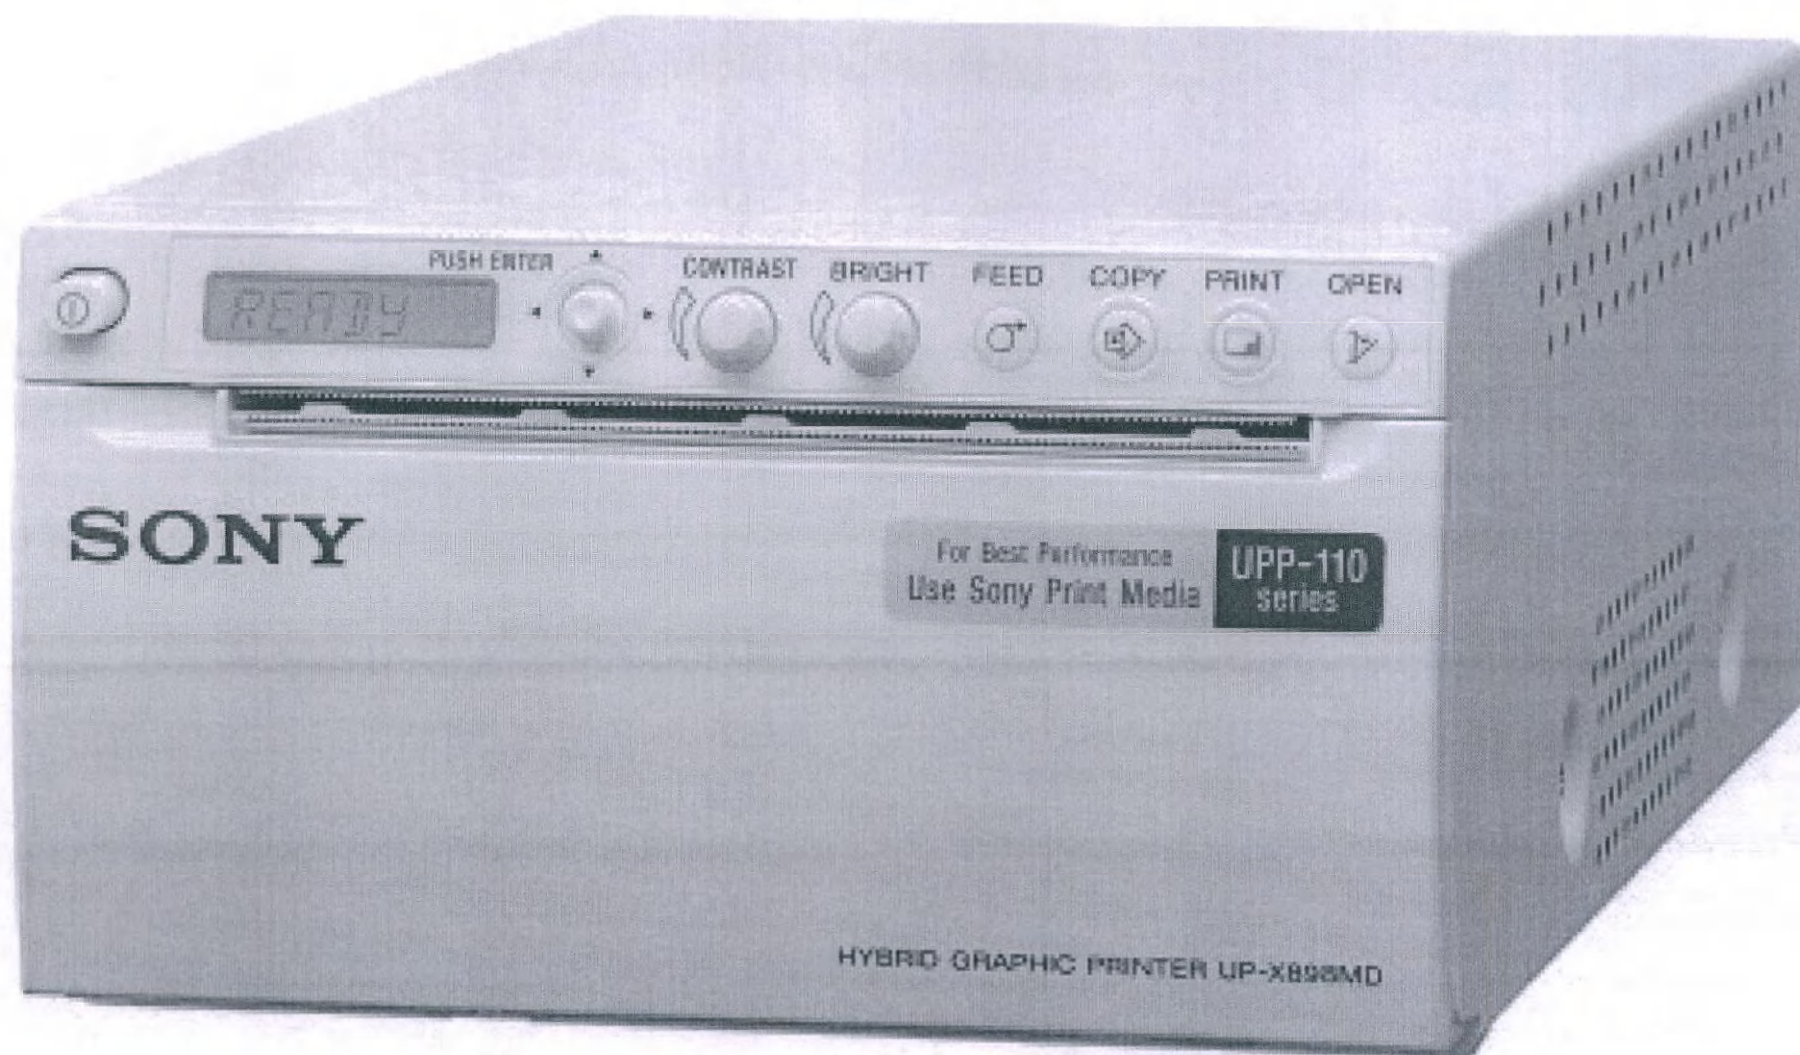

13. Система цифровой рентгенографии CXDI производства Canon Medical System Corporation, Япония;

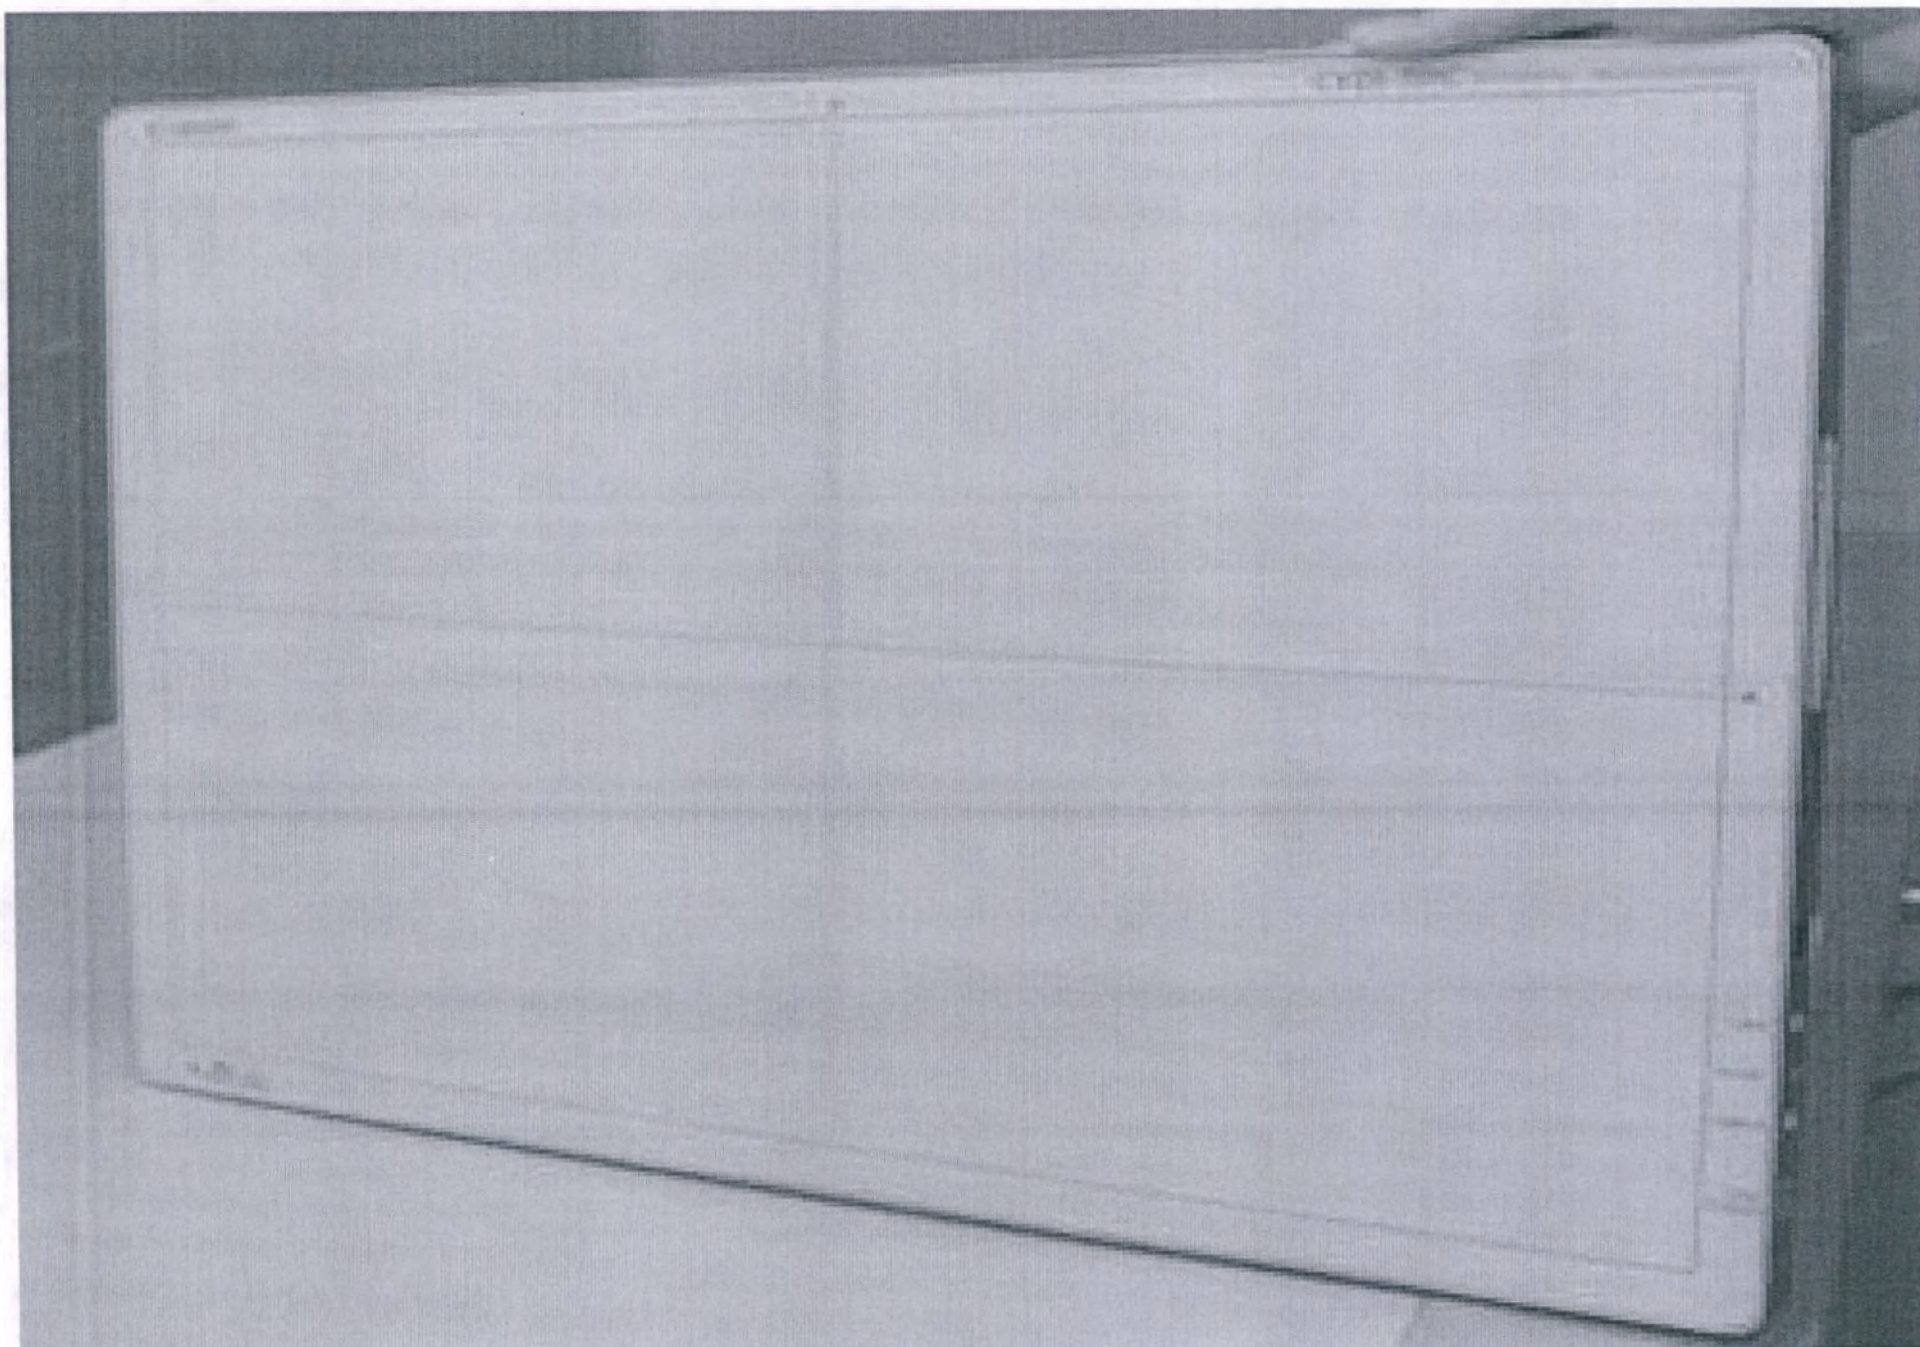

или NX производства Agfa N.V., Бельгия;




или Vxvue производства Vieworks Co., Ltd., Корея;




или ArtPix производства Thales Electron Devices SAS., Франция;




или CS производства Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., Япония;

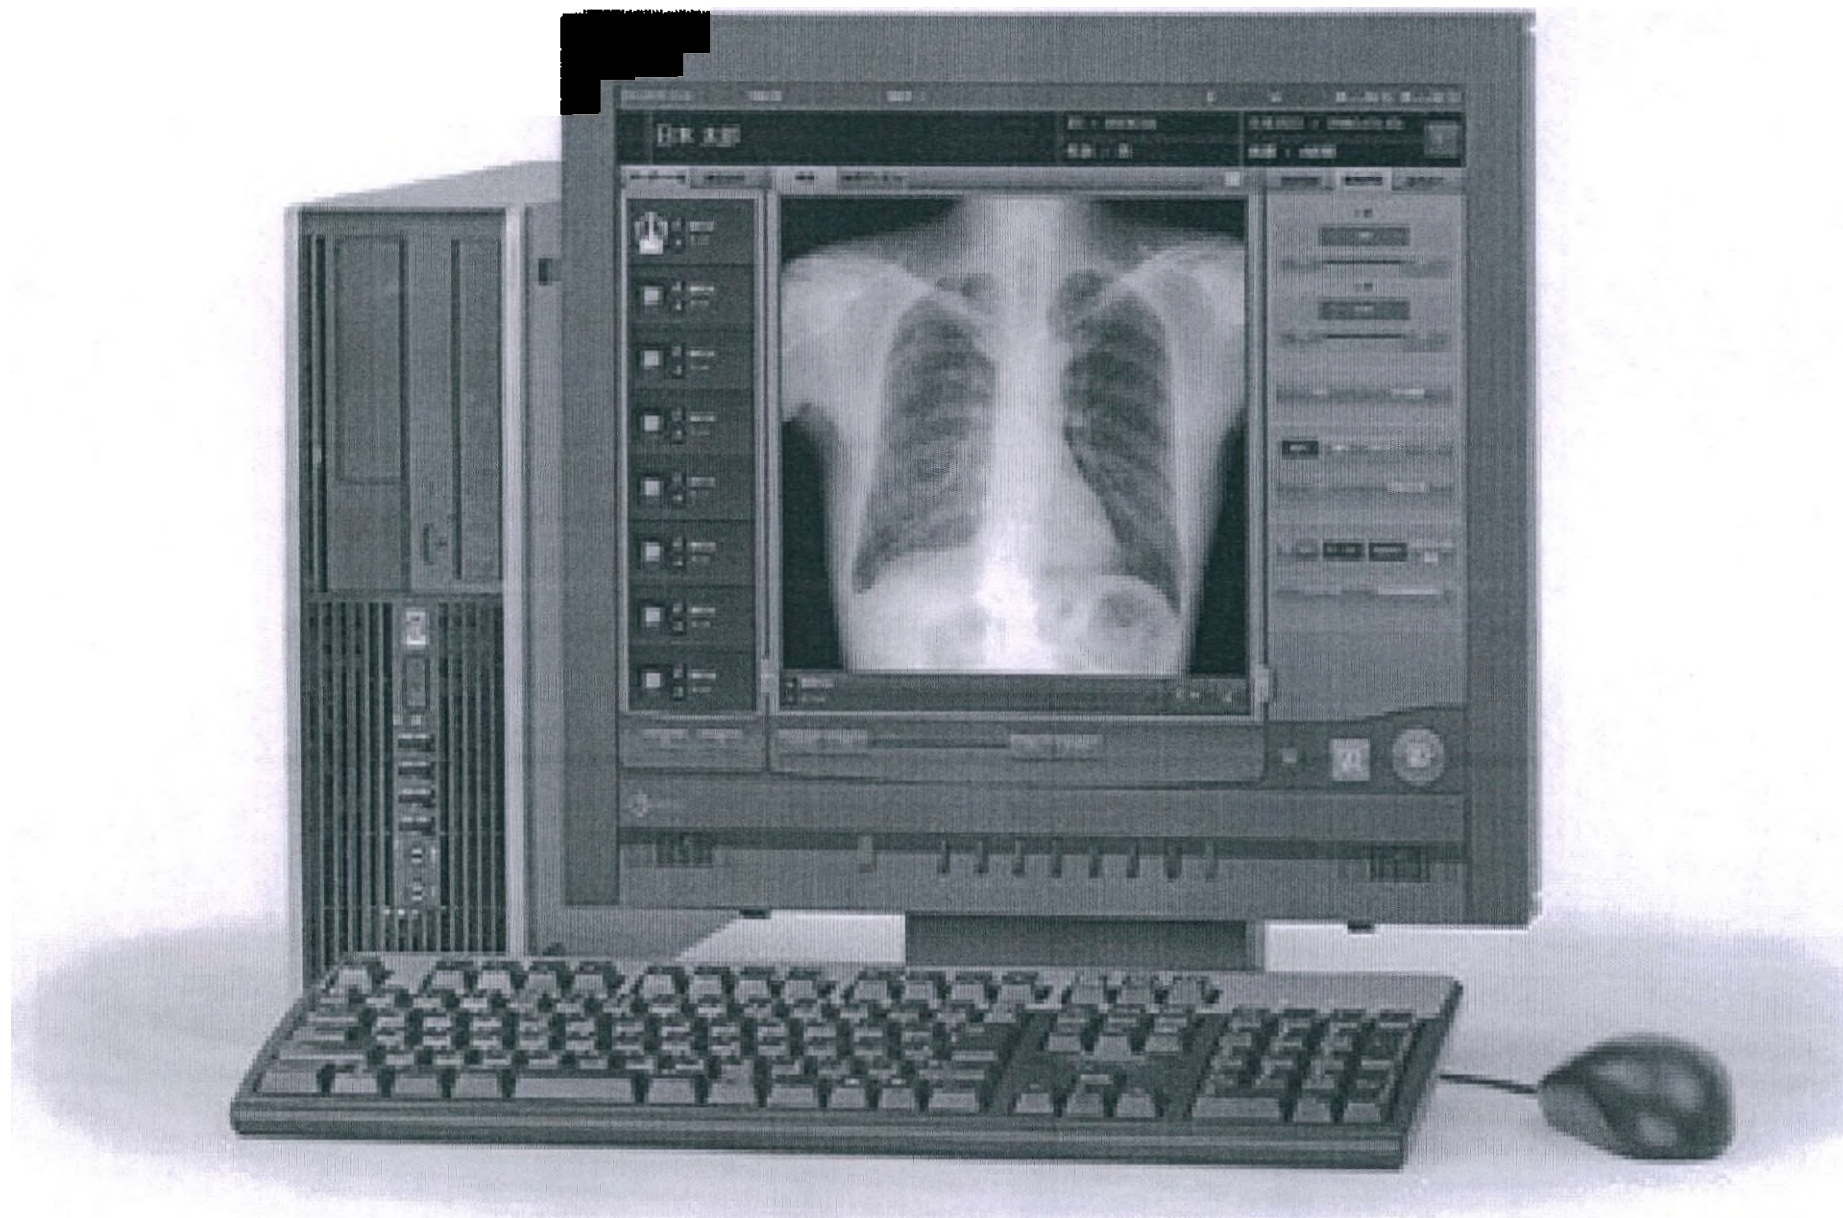


или Nexus DR или DRF производства Varex Imaging Corporation, США;

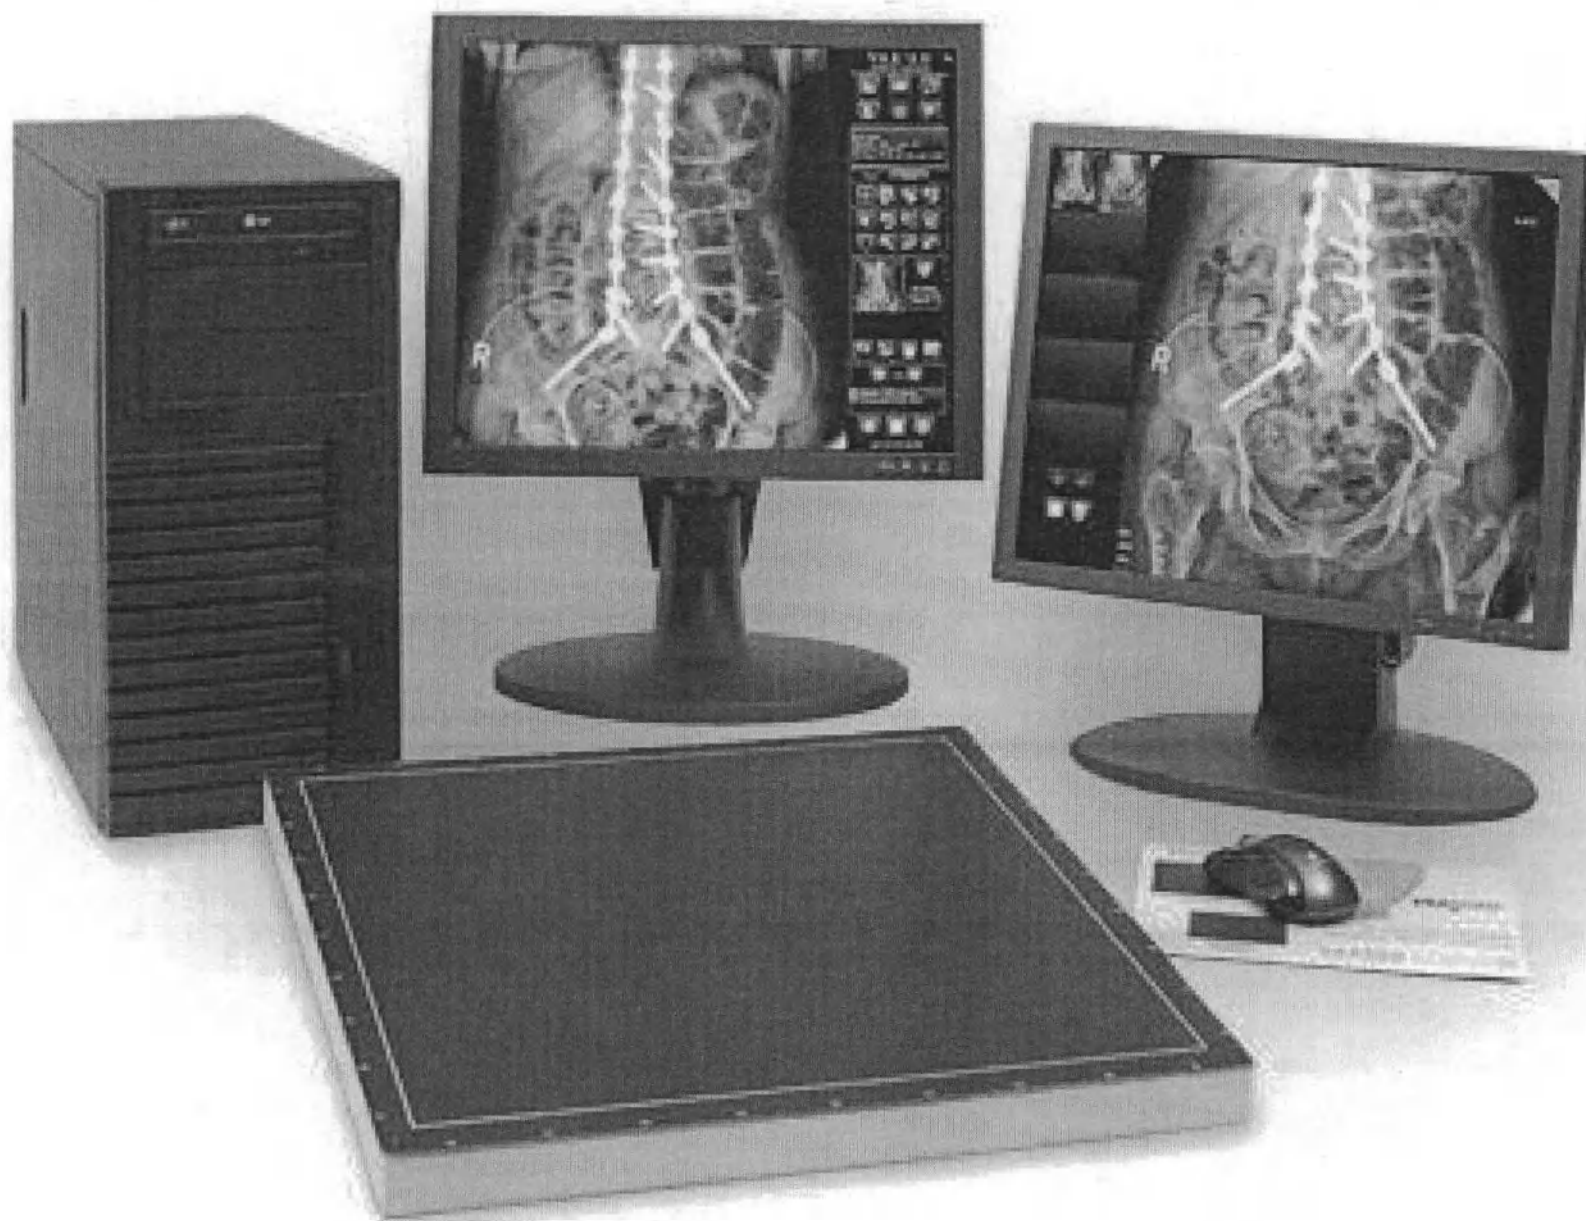

или серии ECONSULE1, производства DRTECH, Республика Корея;

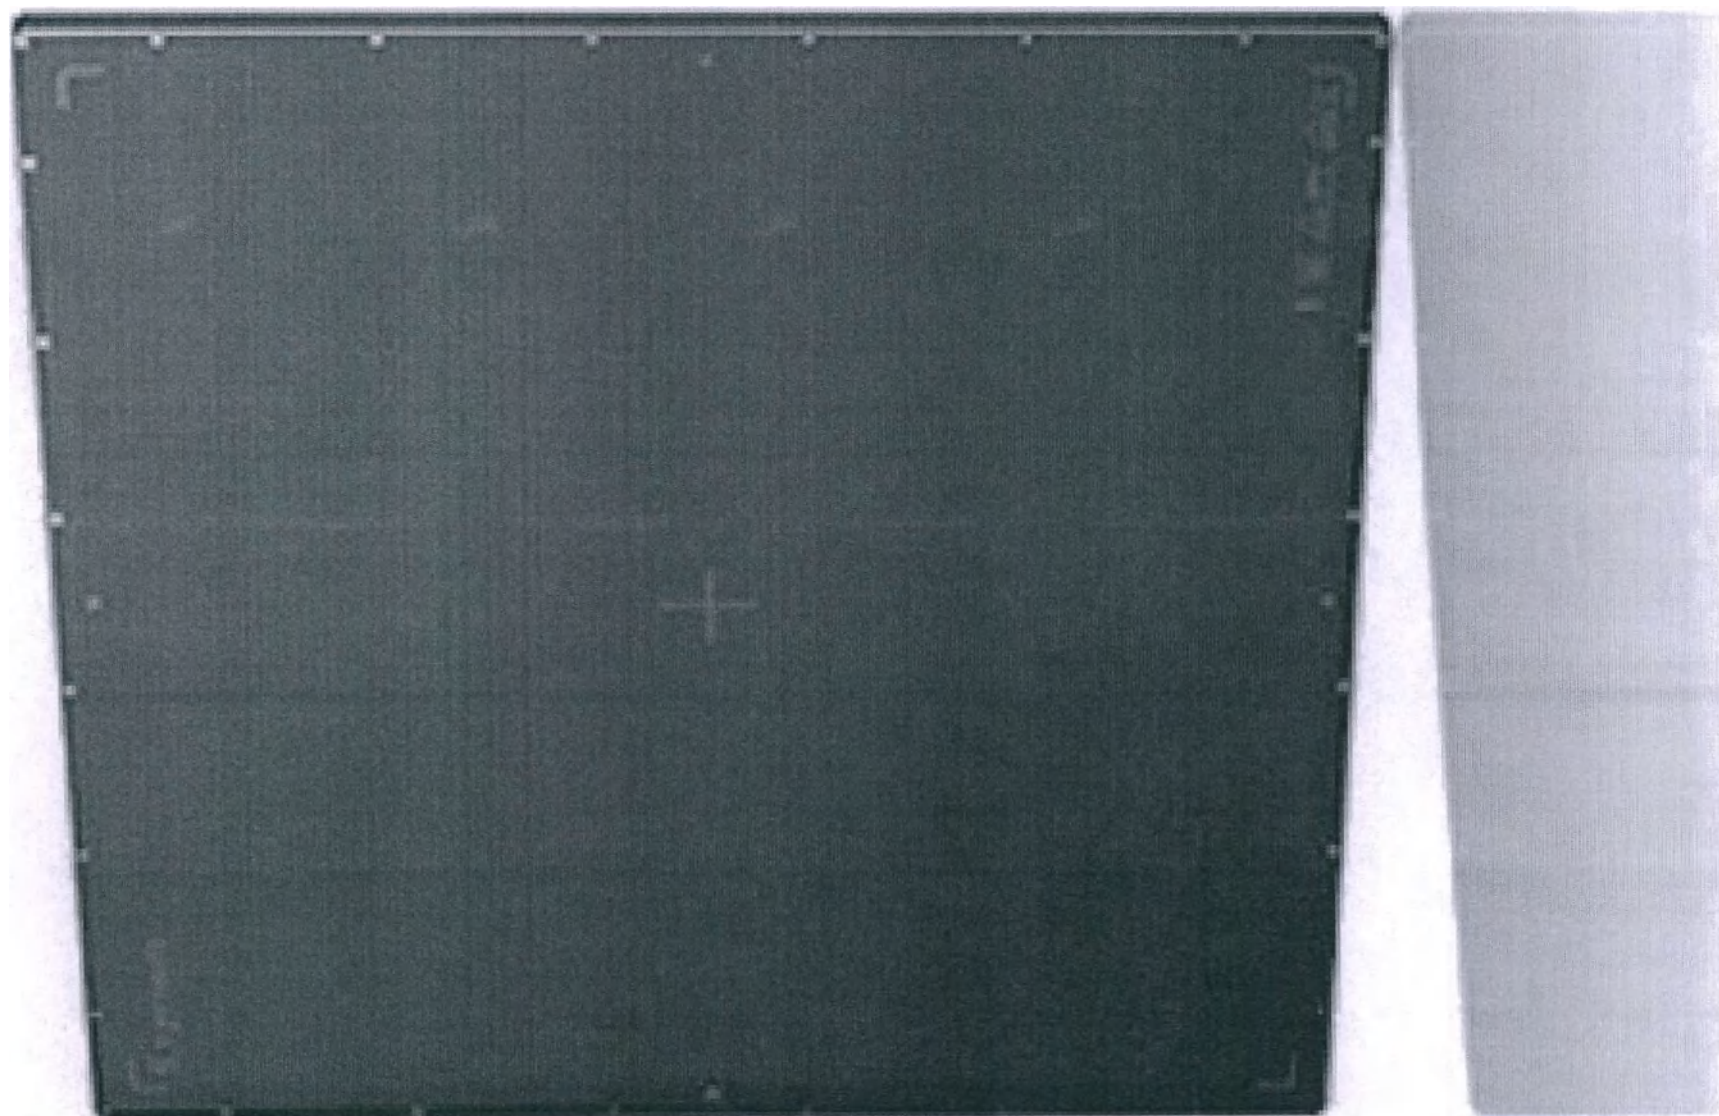


или производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

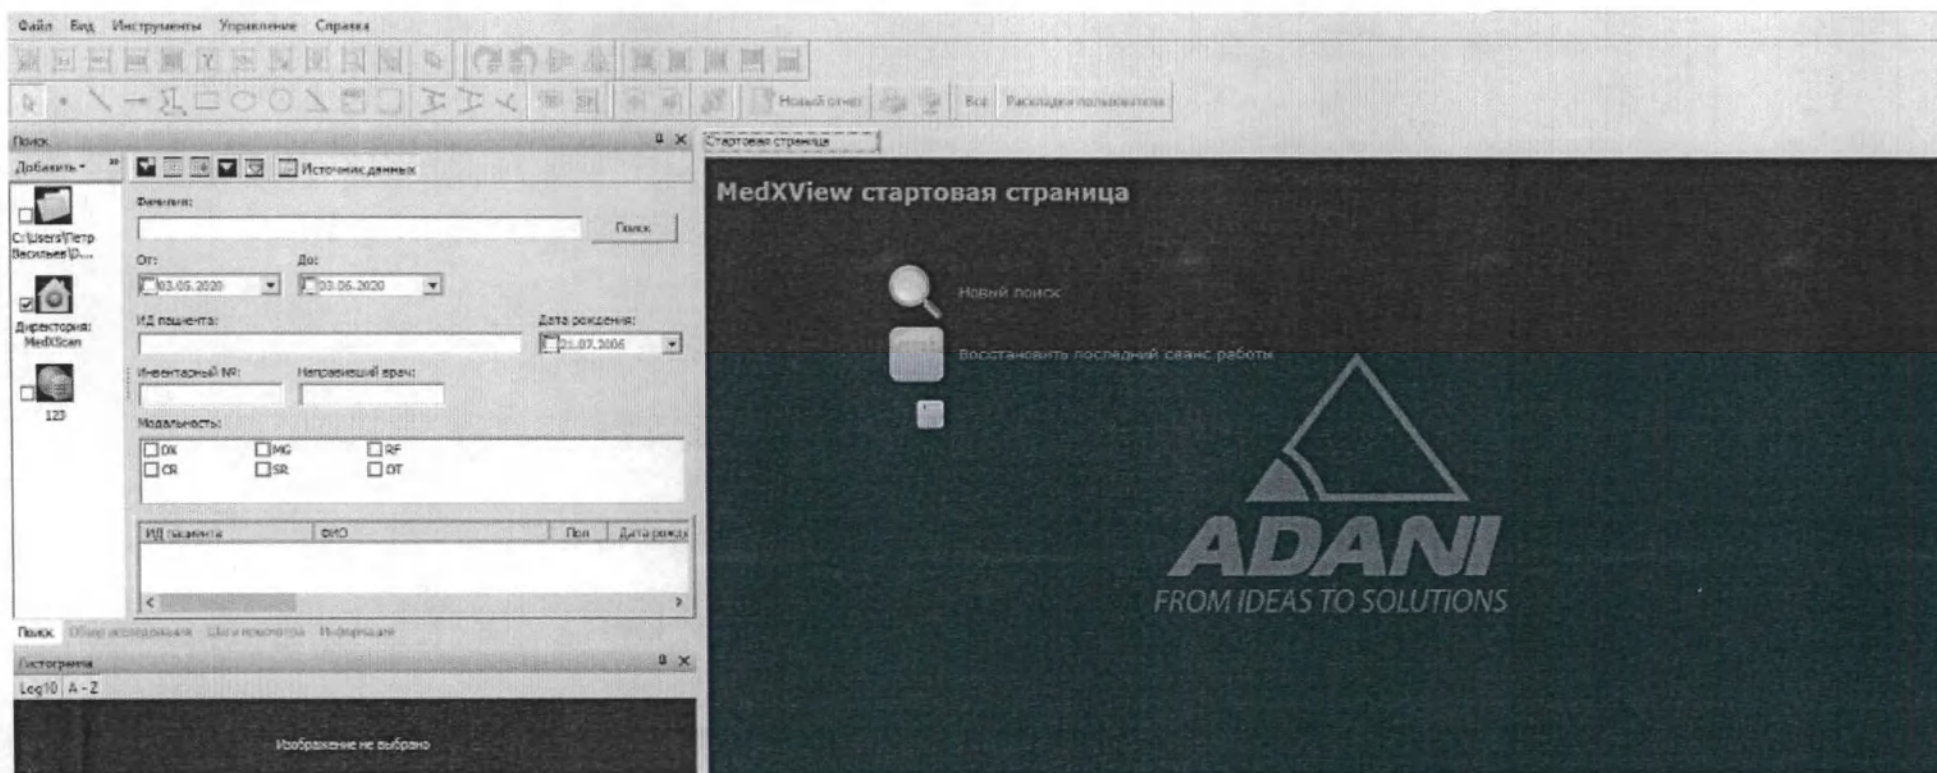


14. Цифровой детектор Pixium производства Thales Electron Devices SAS, Франция;




или цифровой приёмник изображения PaxScan или XRpad производства Varex Imaging Corporation, США;

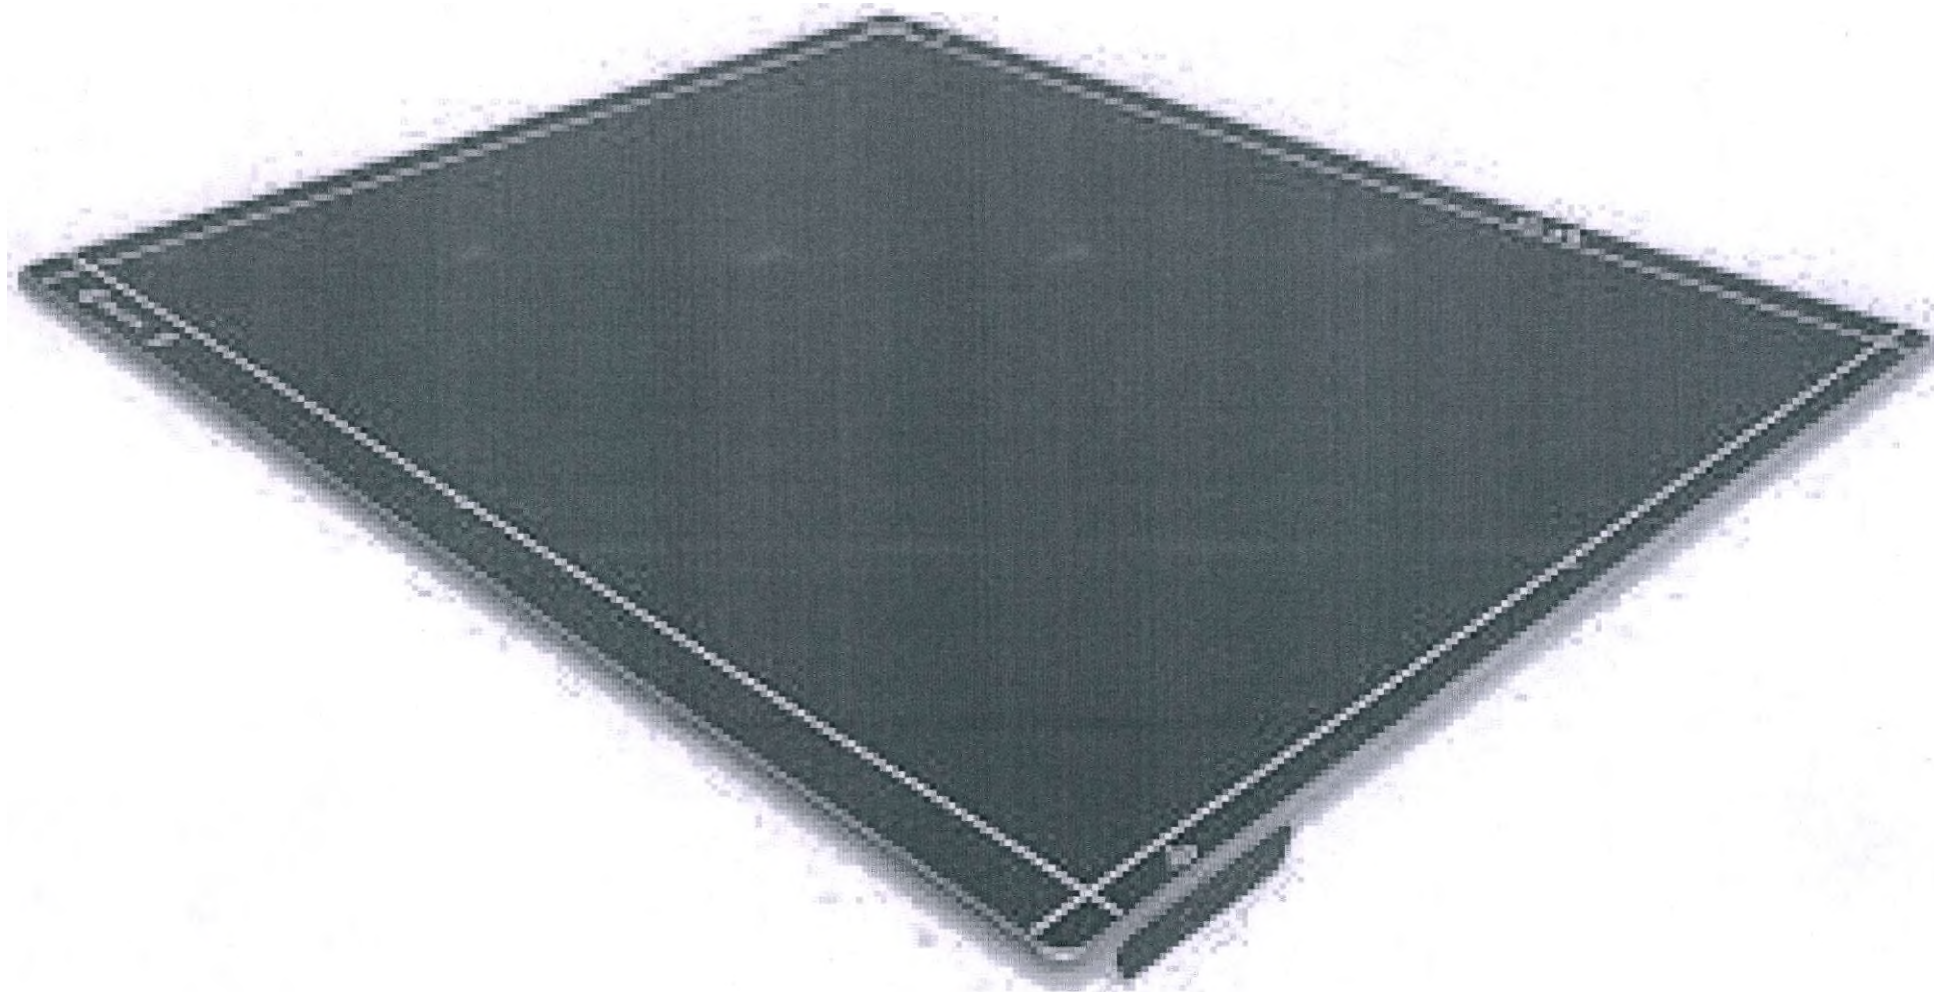

или система цифровой радиологии медицинская диагностическая на основе беспроводного детектора рентгеновского излучения DRX производства Carestream Health Inc., США (РУ № ФСЗ 2012/13085);

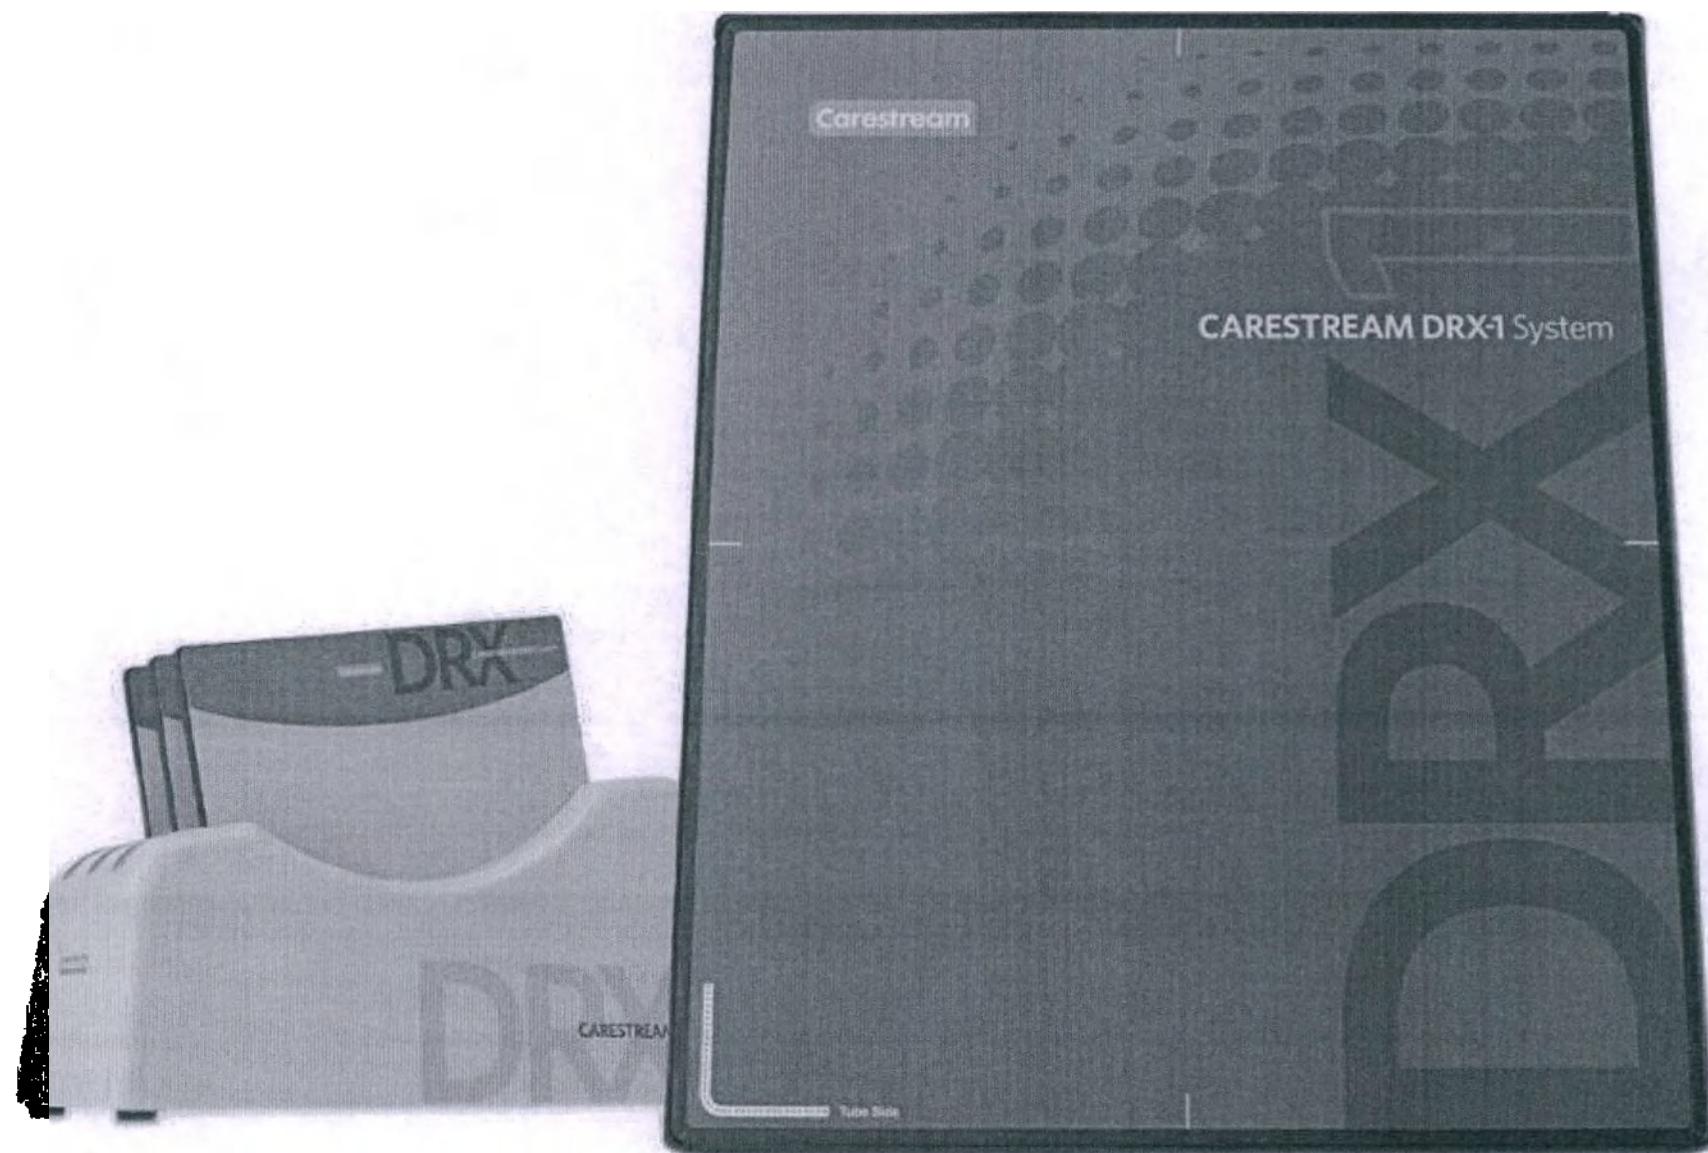


или приёмник рентгенографический цифровой ViVIX-S производства Vieworks Co., Ltd., Республика Корея;

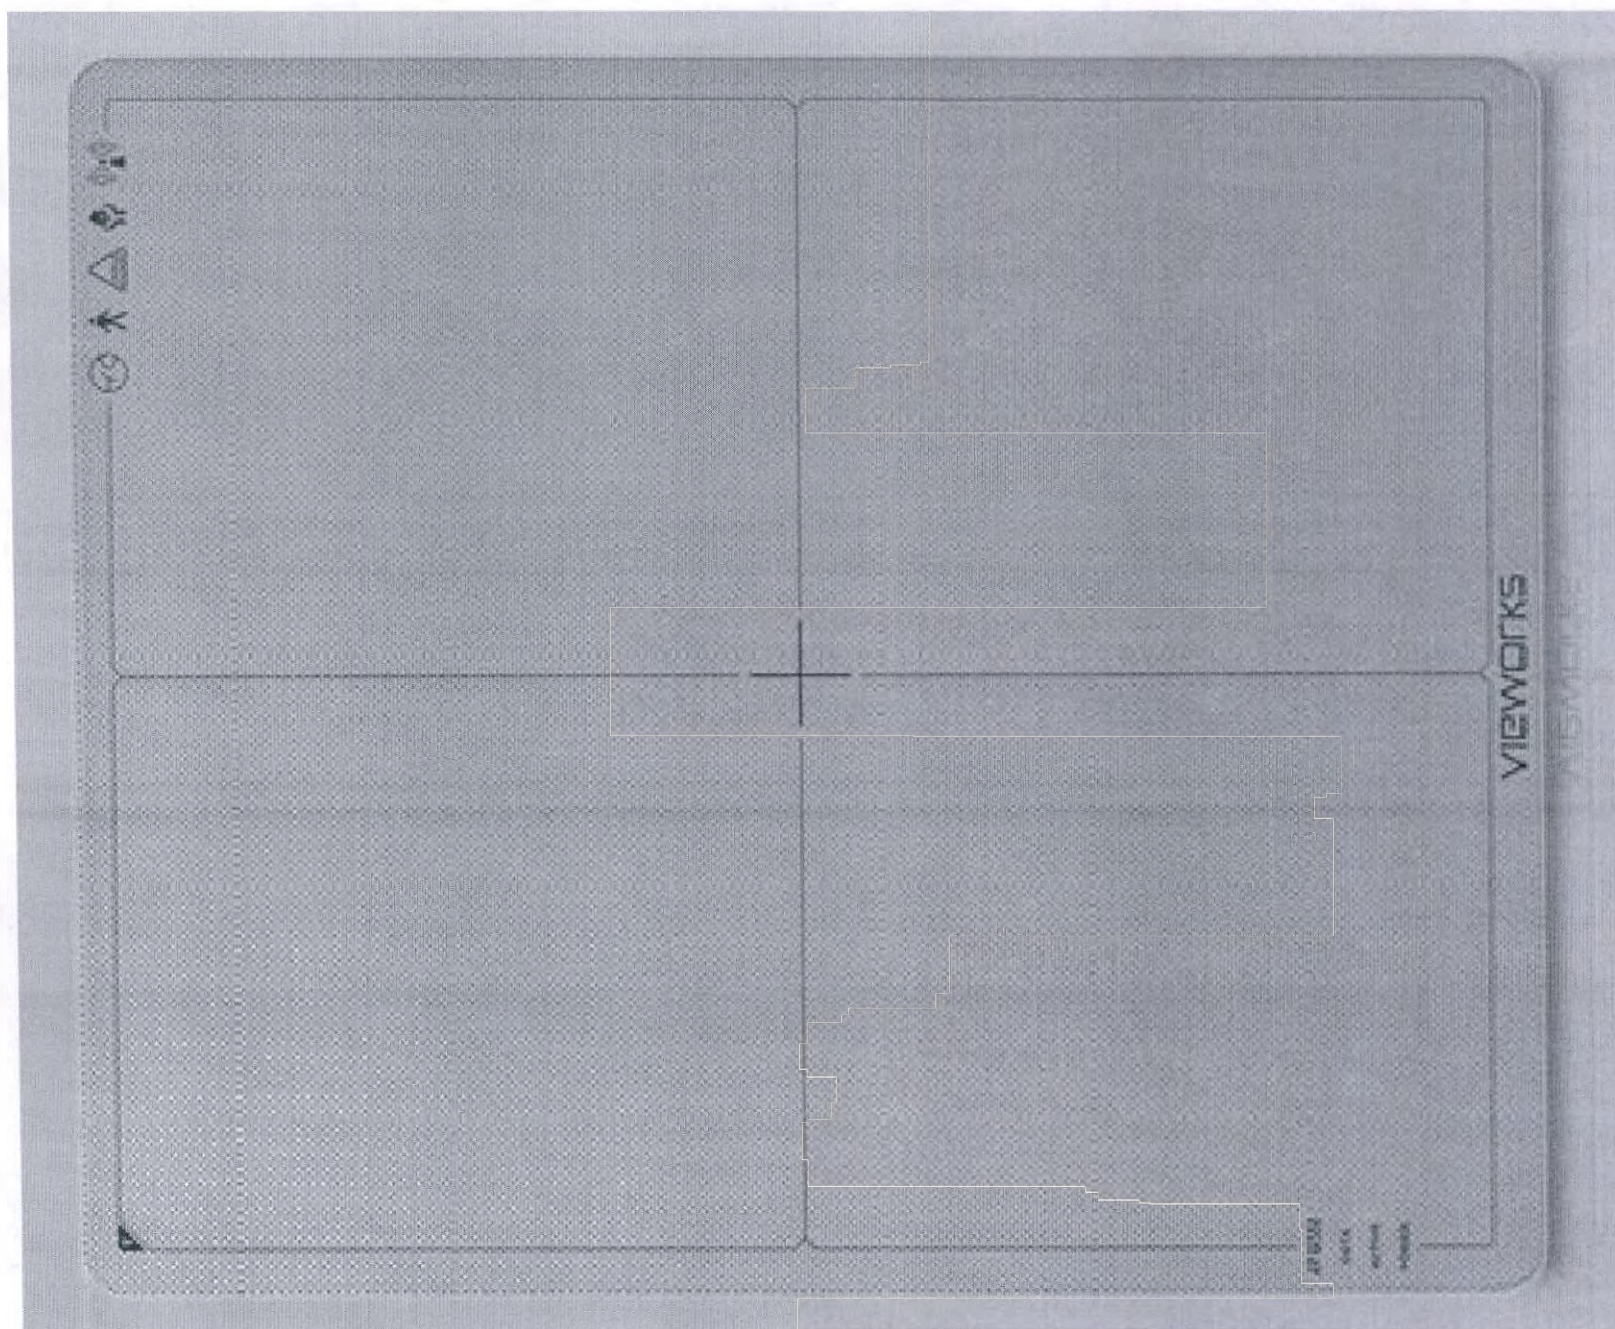


или аппарат цифровой радиологии АэроДР, варианты исполнения: Р-31, Р-51, Р-52 производства Konica Minolta, Inc., Япония (РУ № РЗН 2018/7682);




или Mars, Venu производства iRay Technology Co Ltd., Китай;

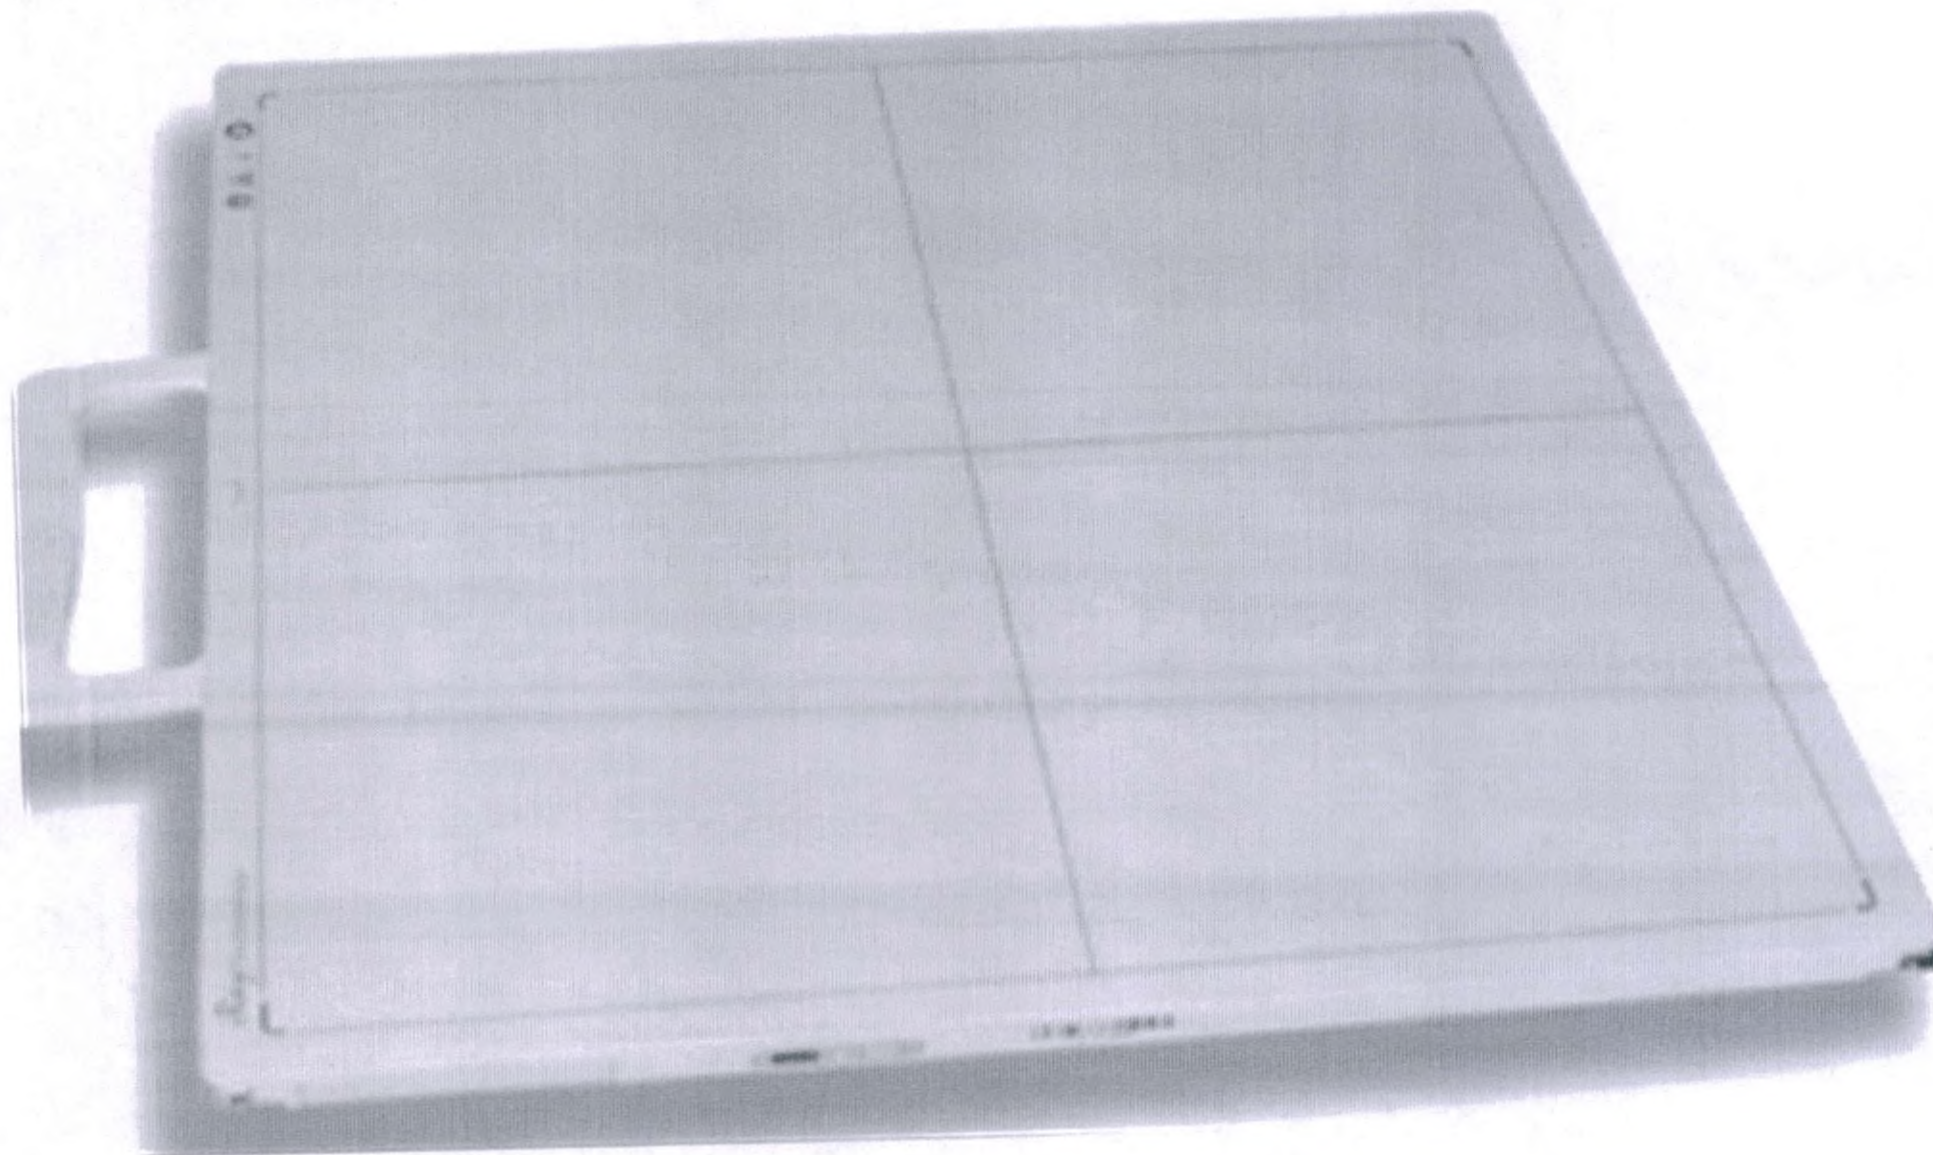


или EVS производства DRTECH, Республика Корея;

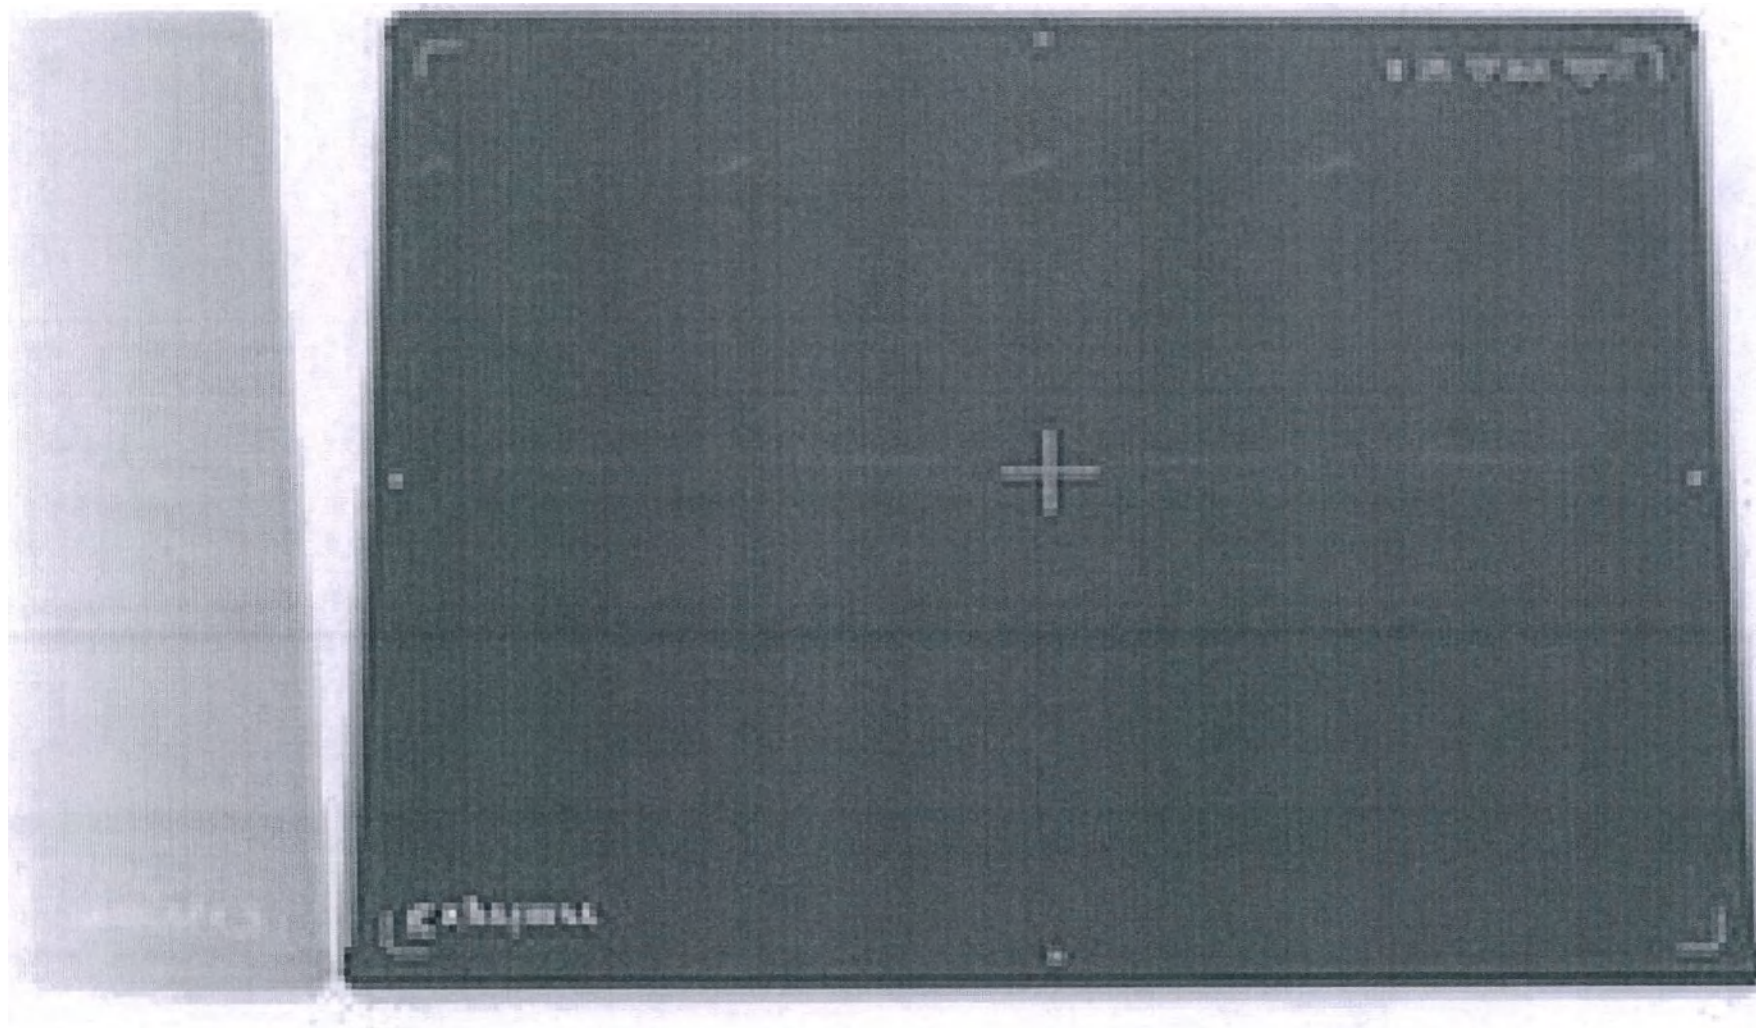


или CareView производства Care Ray Medical System Co, Китай;

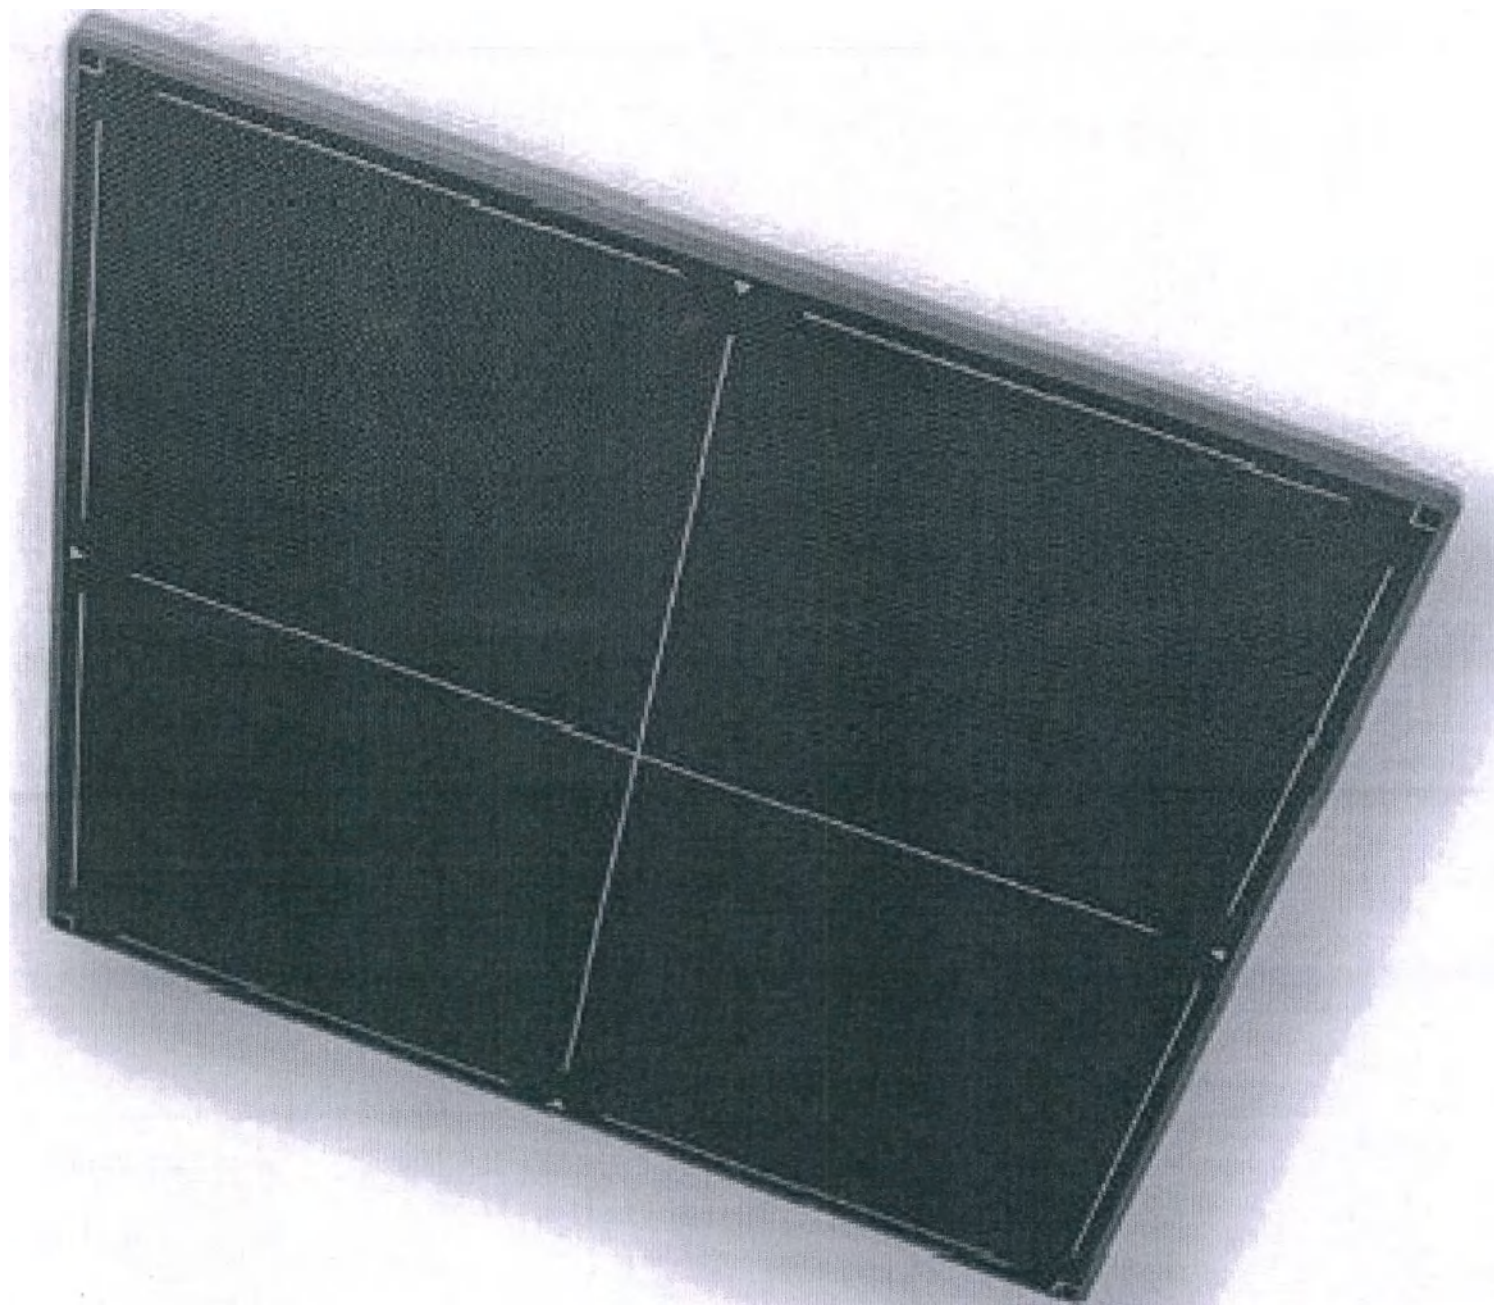


или CXDI производства Canon Medical System Corporation, Япония.

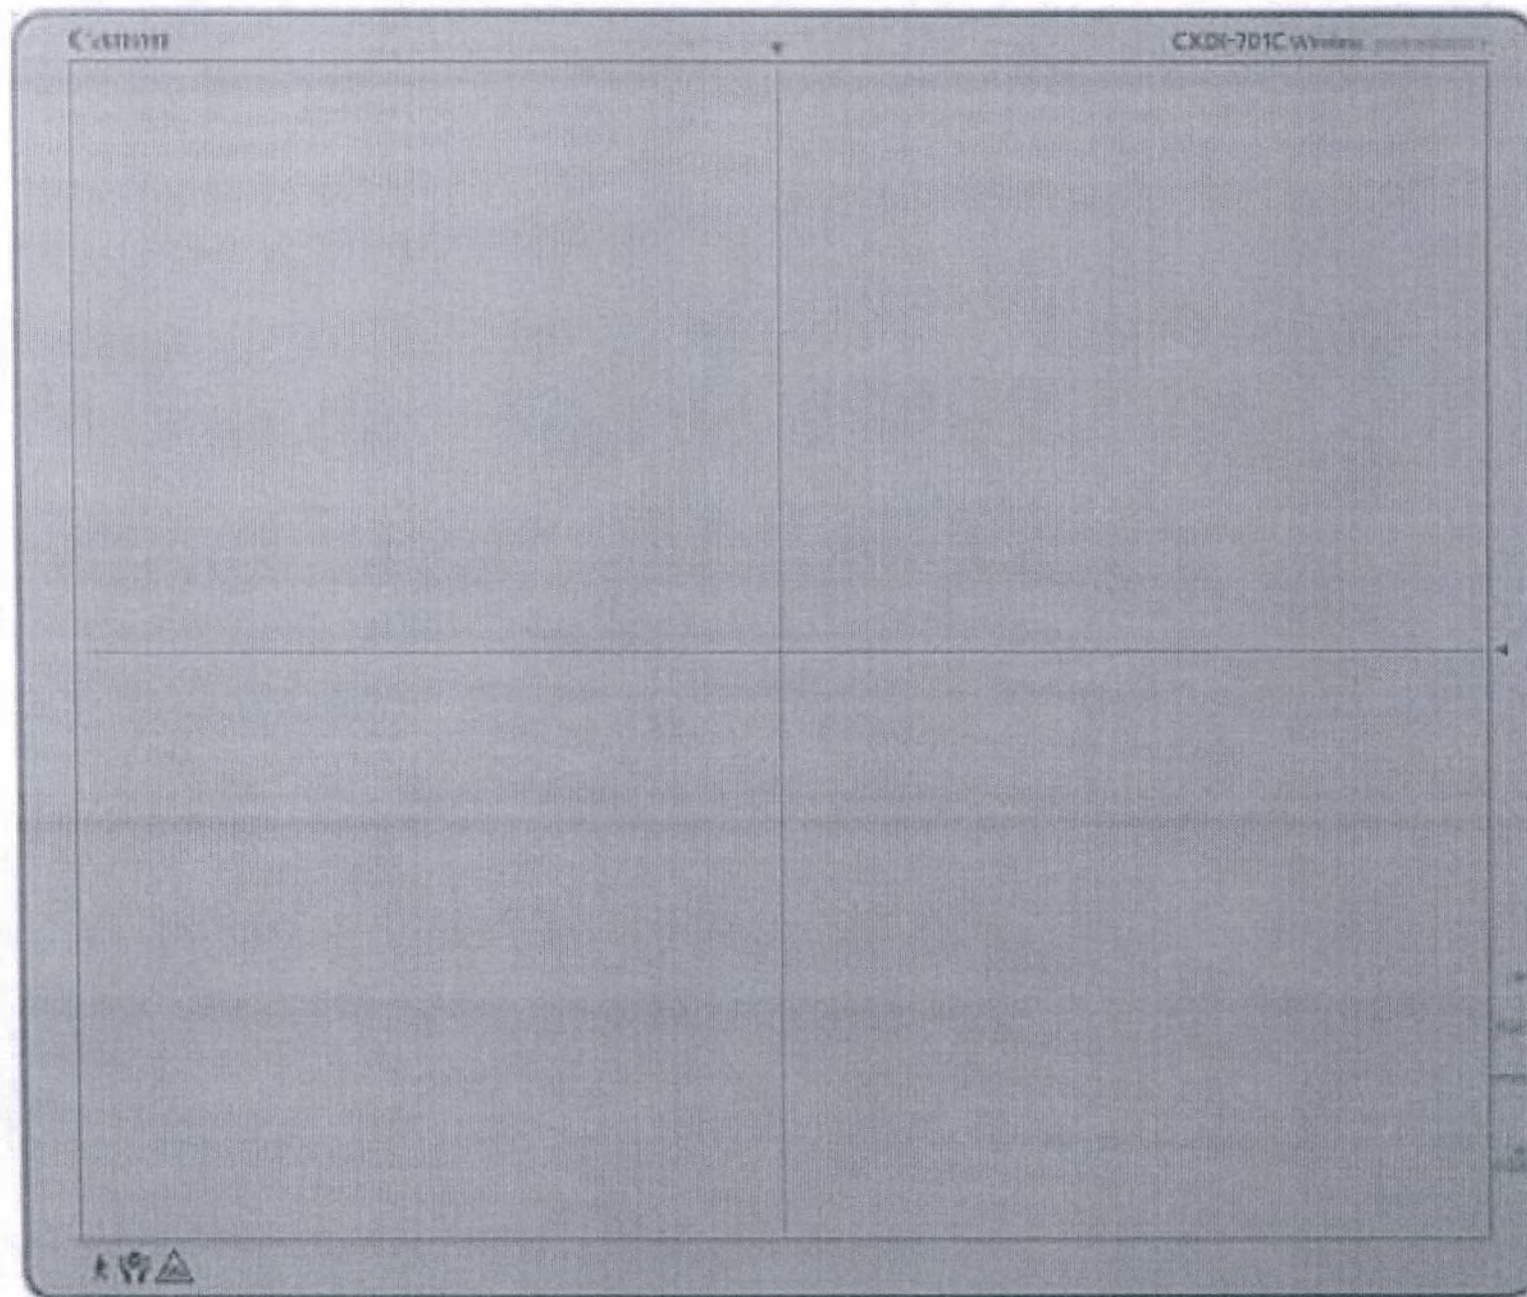


15. Негатоскоп «ИКСВЫЮ» по ТУ 9441-023-74487176-2011 производства ООО «ДИКСИОН», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/11086);

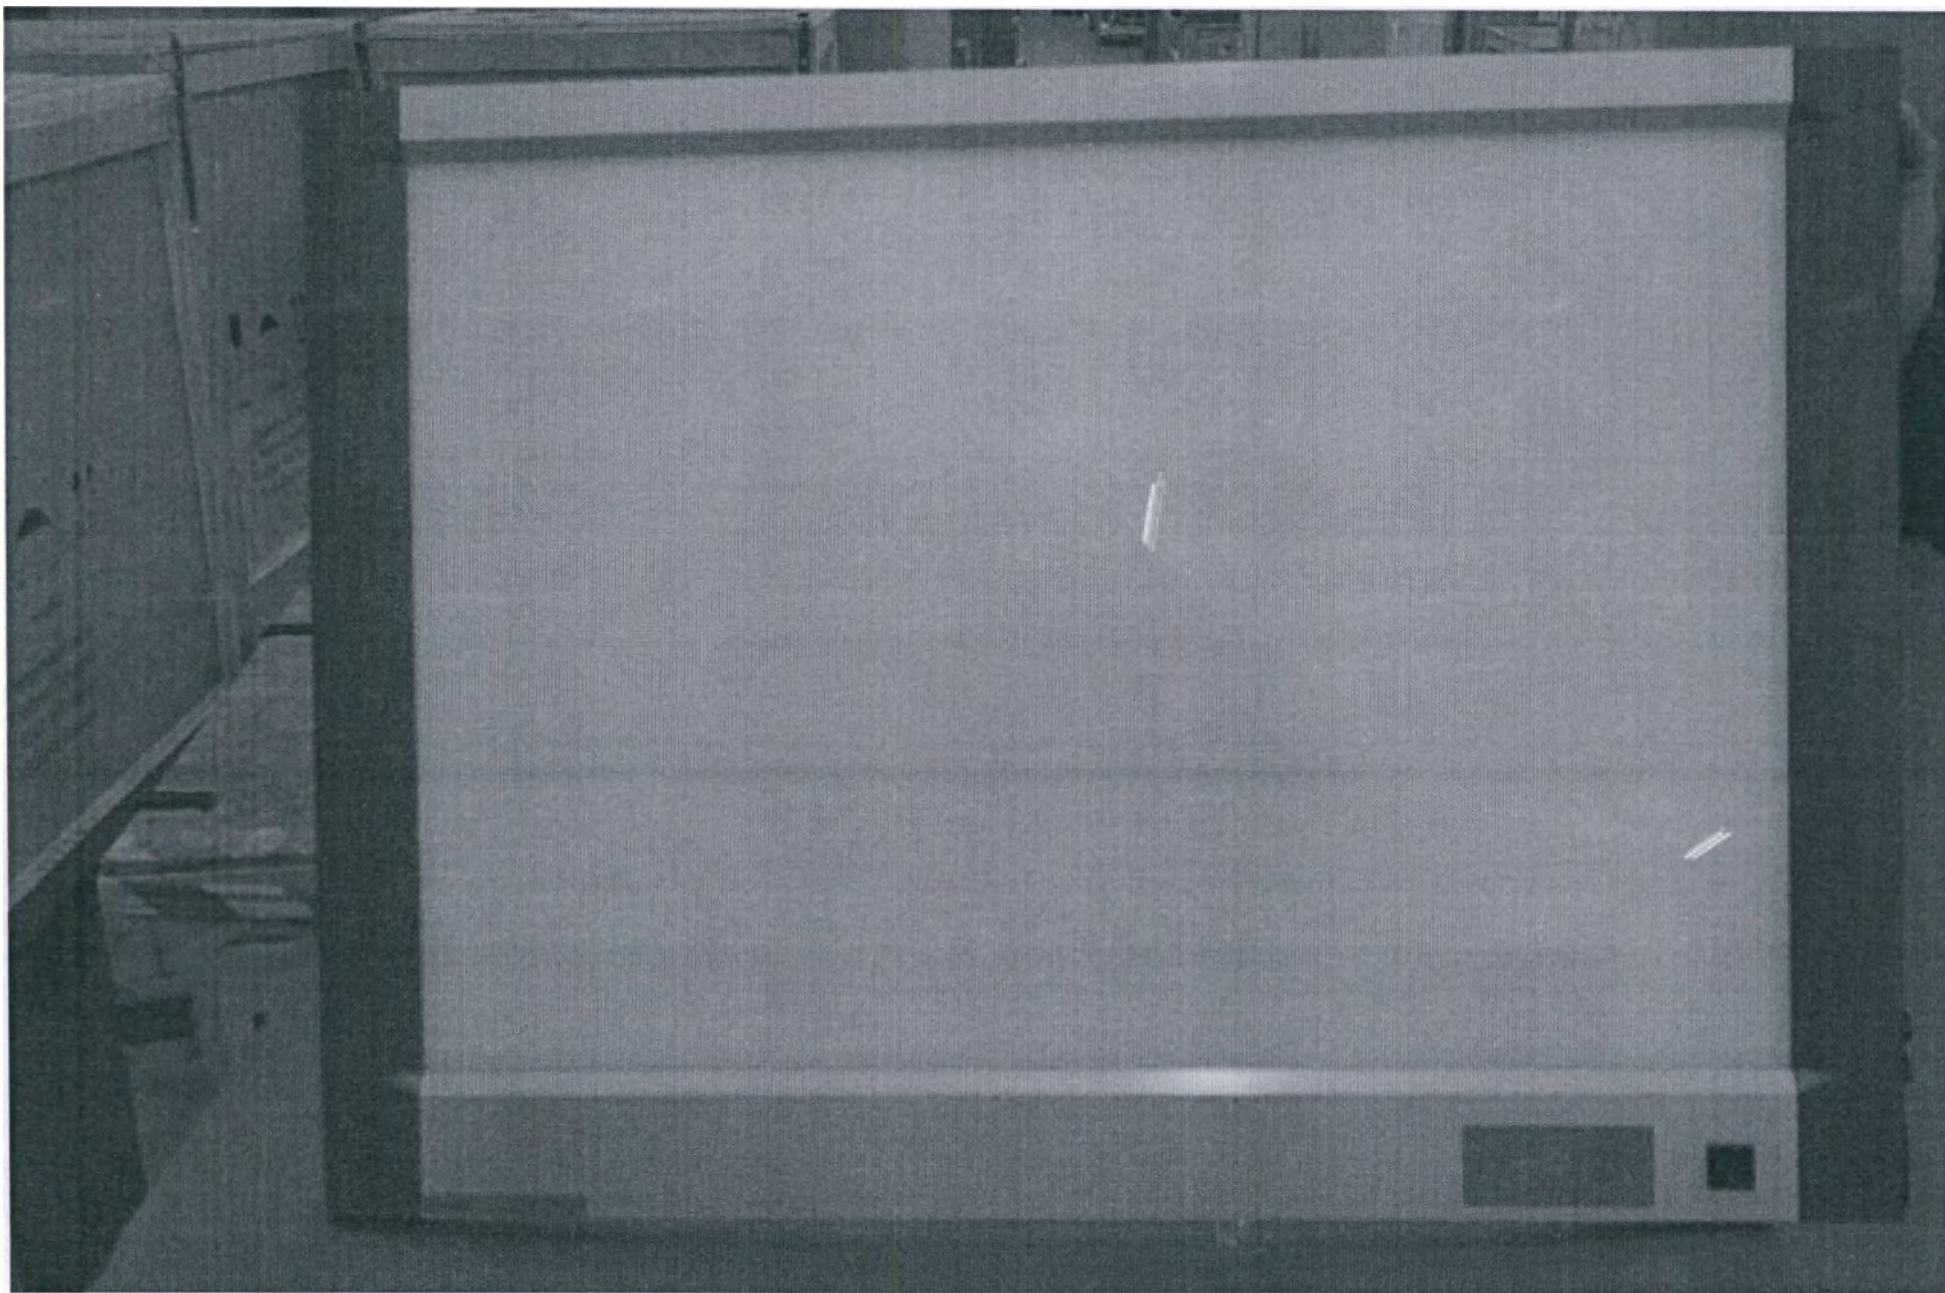


или негатоскоп общего назначения Нег-Н-РМ по ТУ 9452-001-46782692-99 производства ООО «Рентген-Комплект» (РУ № ФСР 2008/02874);

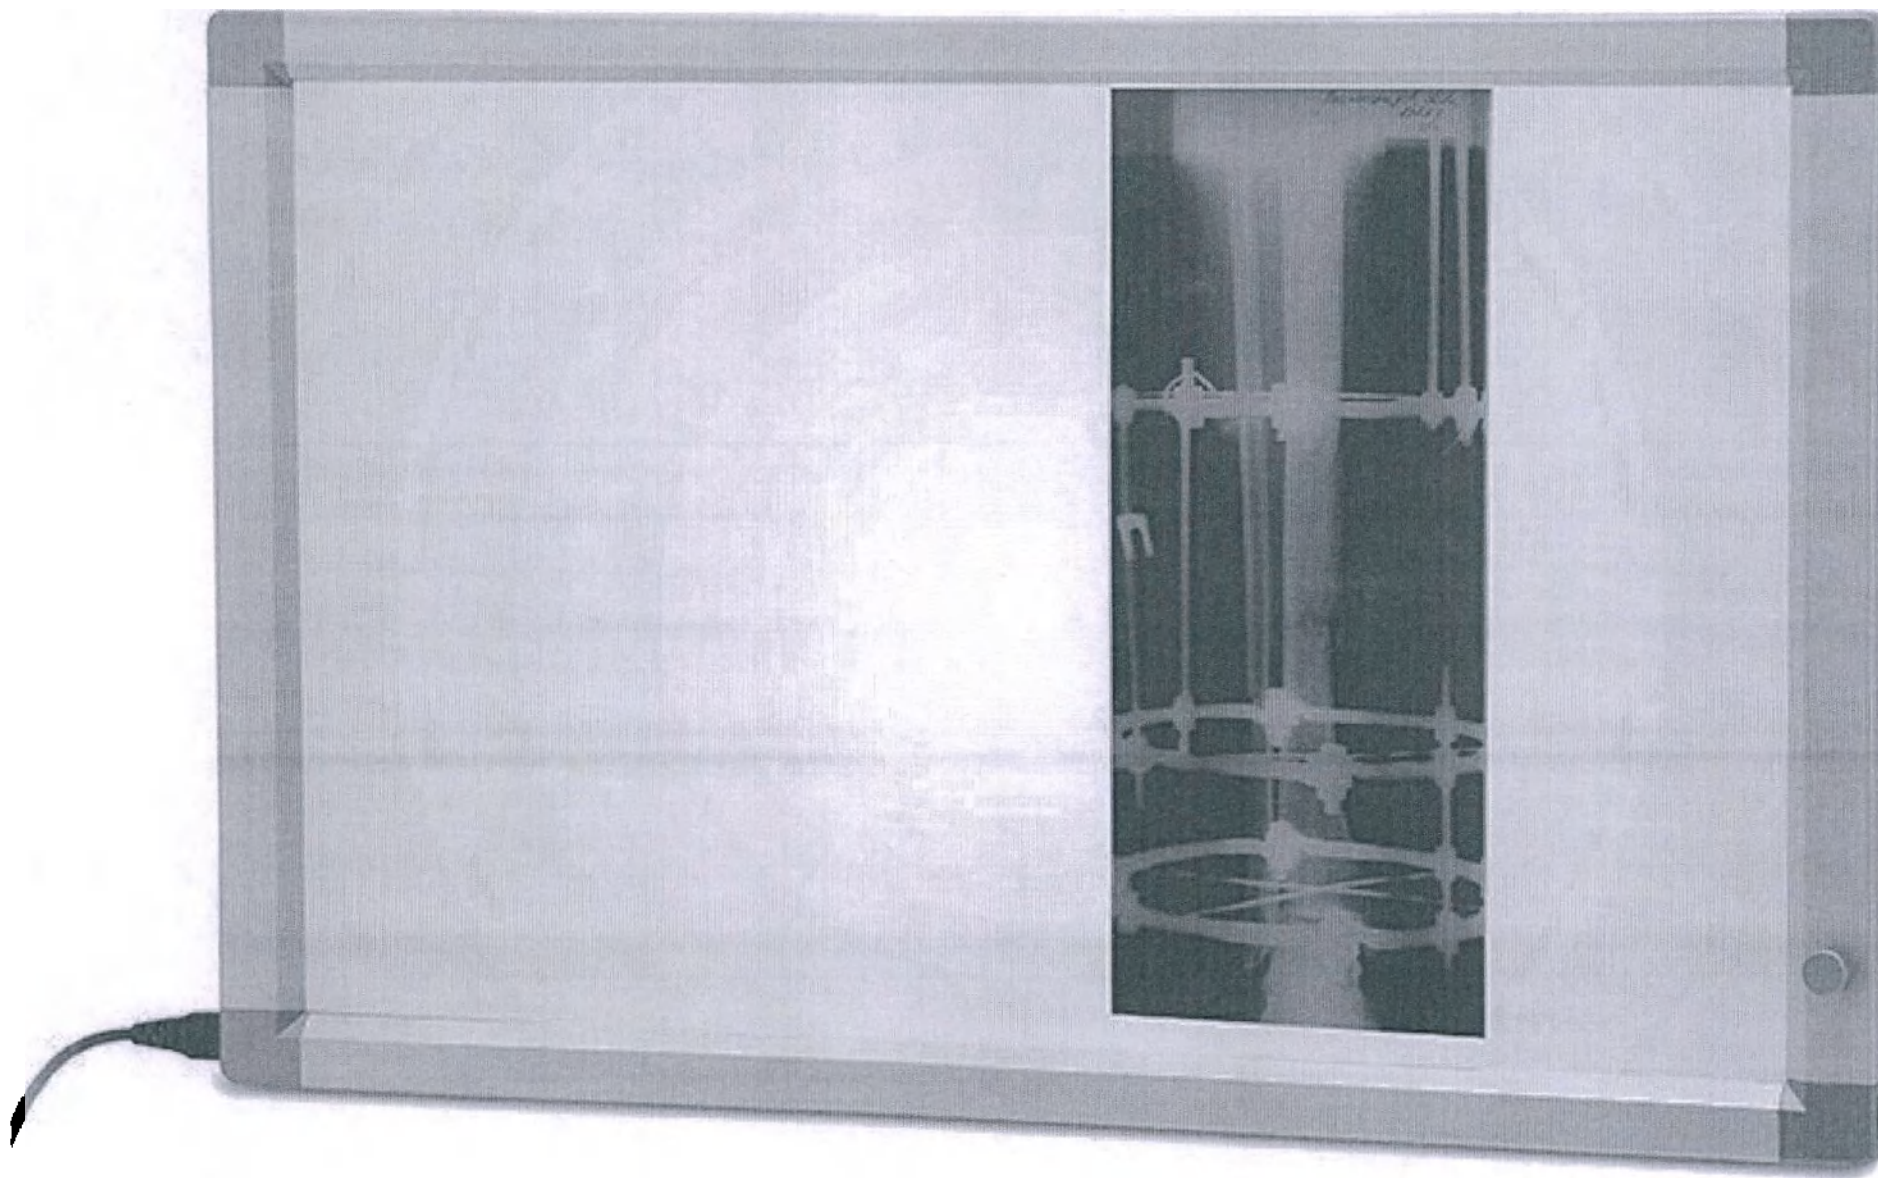


или негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011 производства ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований» (РУ № ФСР 2011/10889);

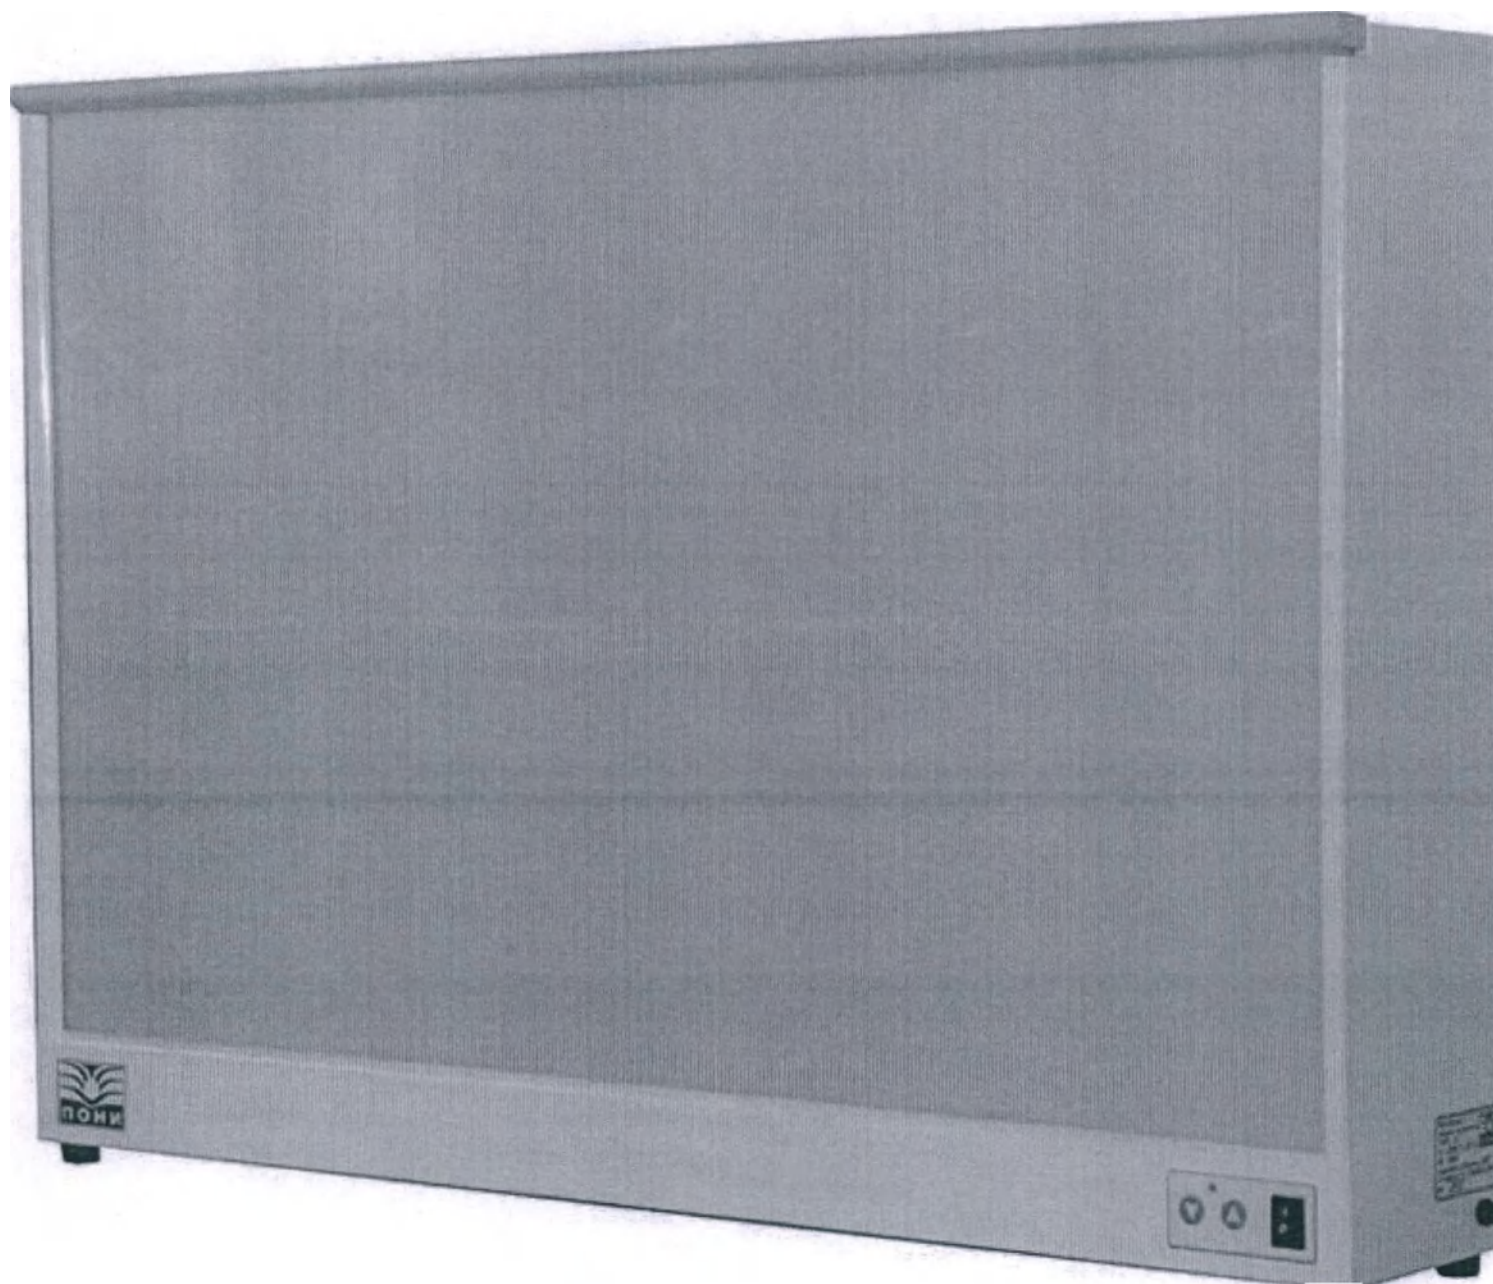

или негатоскоп «АРД» по ТУ 9452-001-35912766-2015 производства ООО «Витако» (РУ № РЗН 2016/4027);

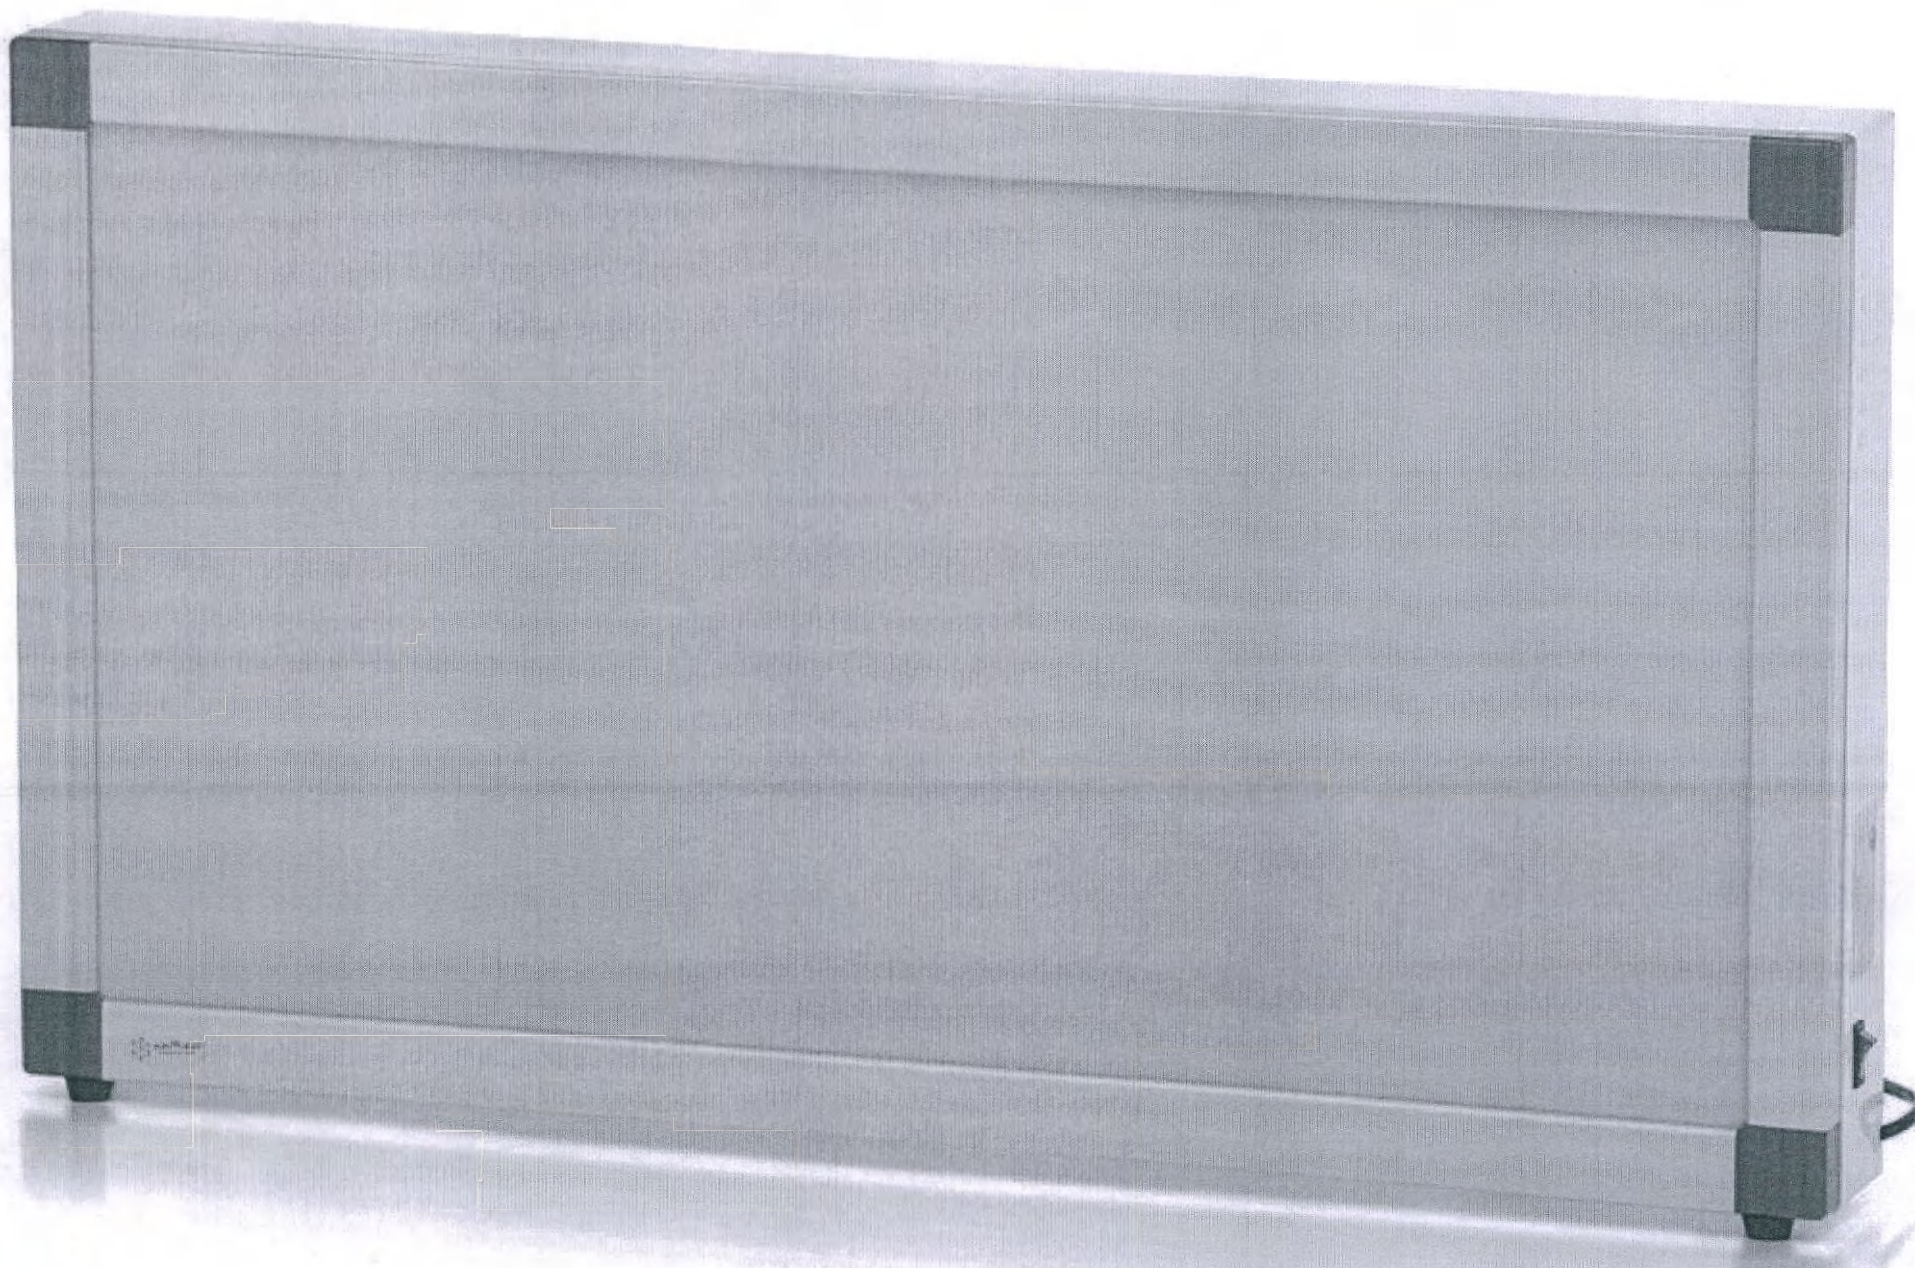


или негатоскоп медицинский серии Н по ТУ 9452-006-52132018-2015 производства ООО "Здоровый Мир" (РУ № РЗН 2016/4440);

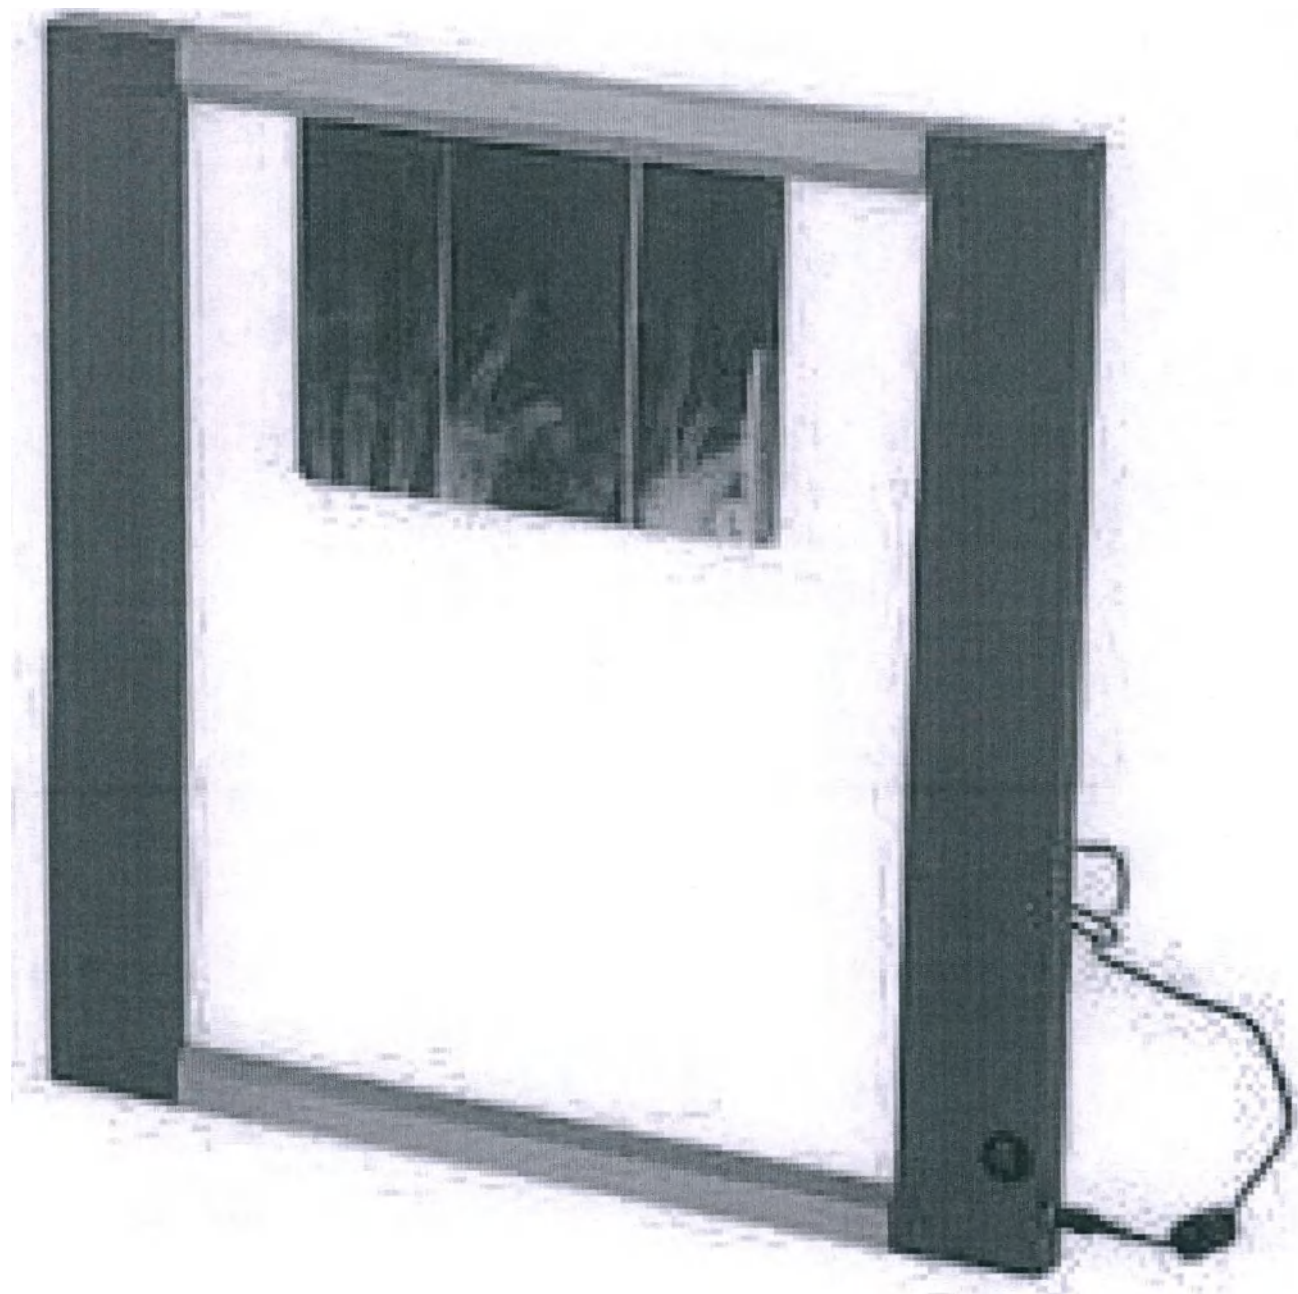


или негатоскопы медицинские НМ модификации: НМ-1, НМ-2, НМ-3 производства ООО «Мединдустрия Сервис» (РУ № РЗН 2013/1376).



16. Рентгенозащитное стекло/окно, эквивалент ослабления не менее 2,5 Рb «ТИССА-РР» производства ООО «ТИССА», Республика Беларусь;

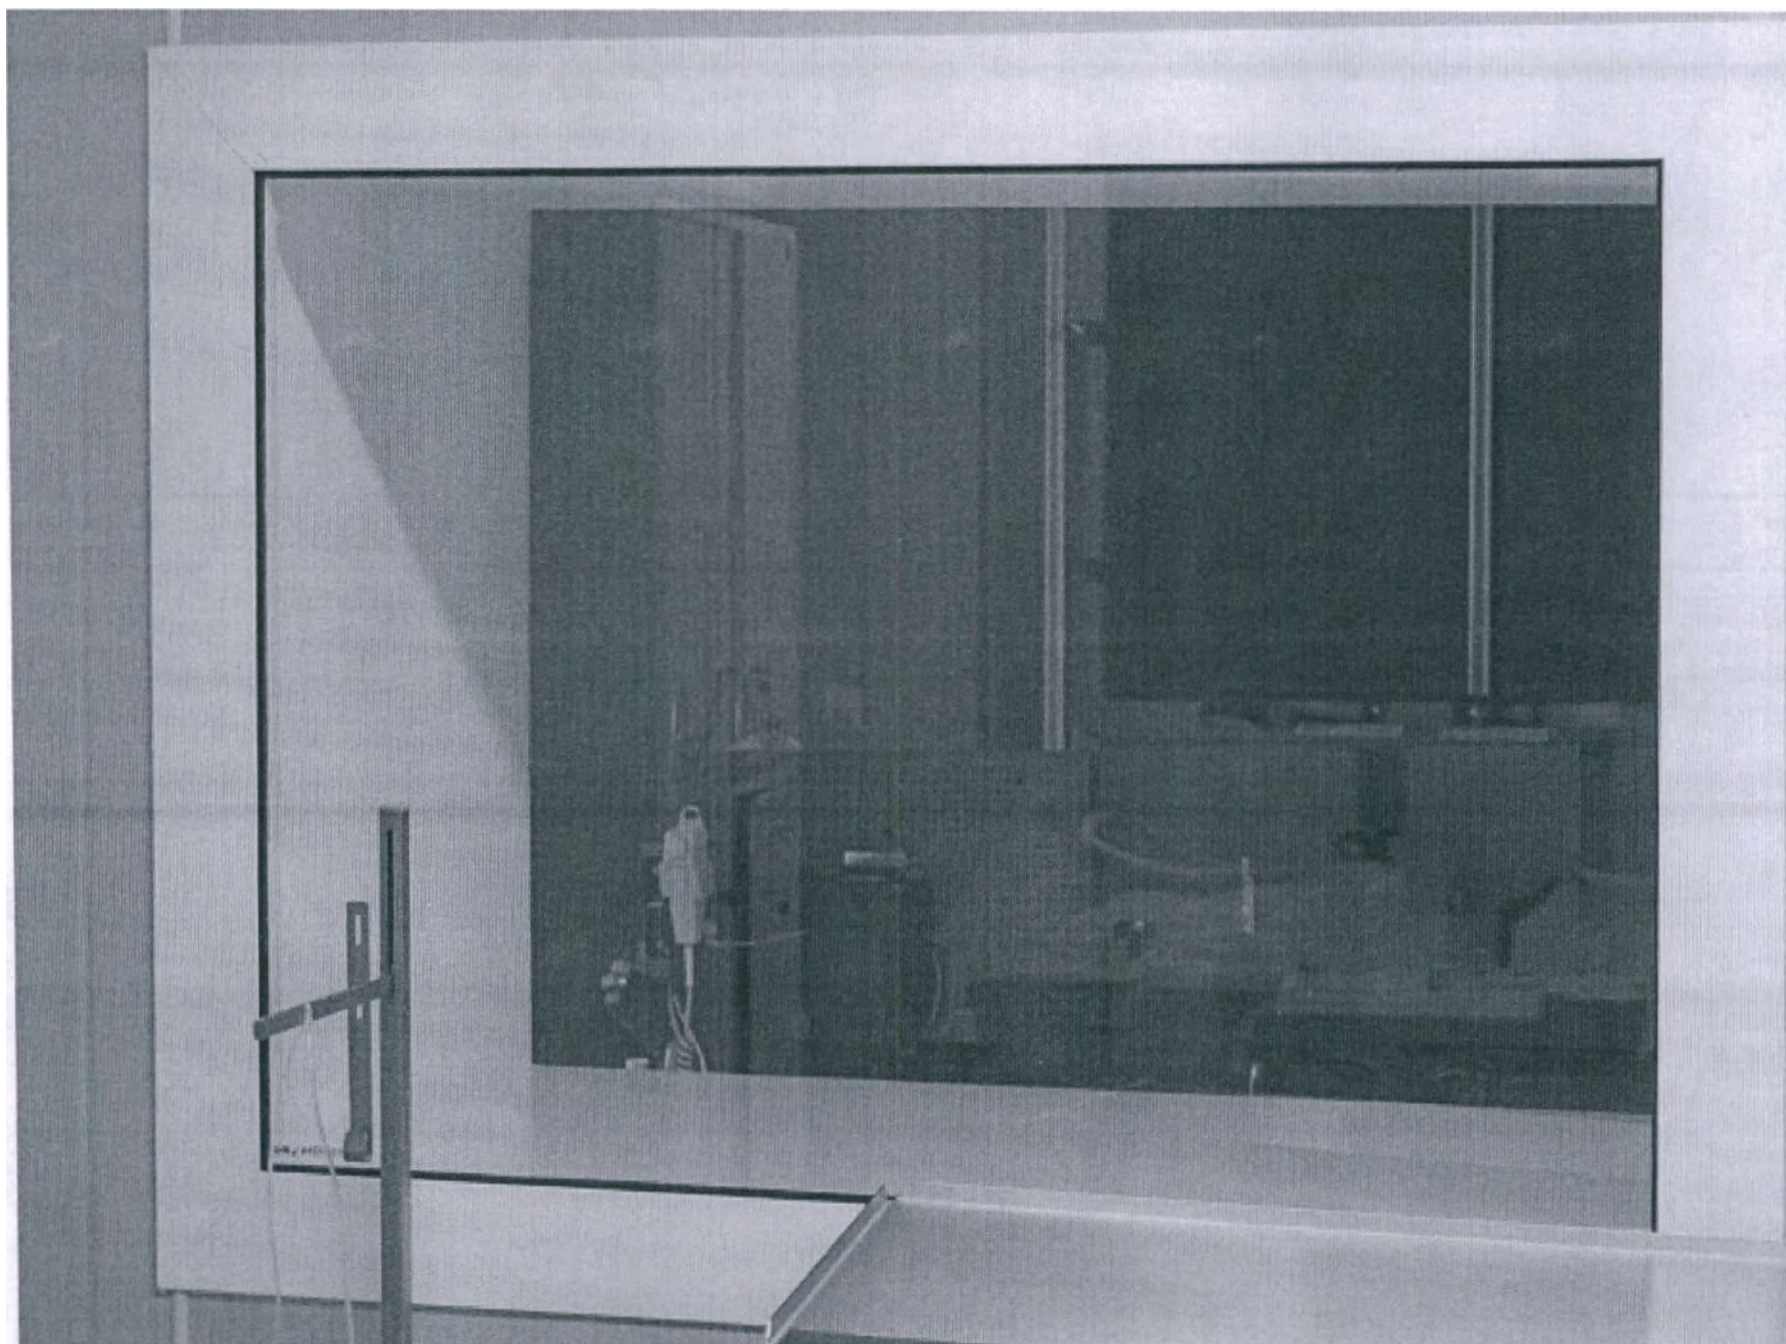



или РЕНЕКС ОСРЗ производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия.

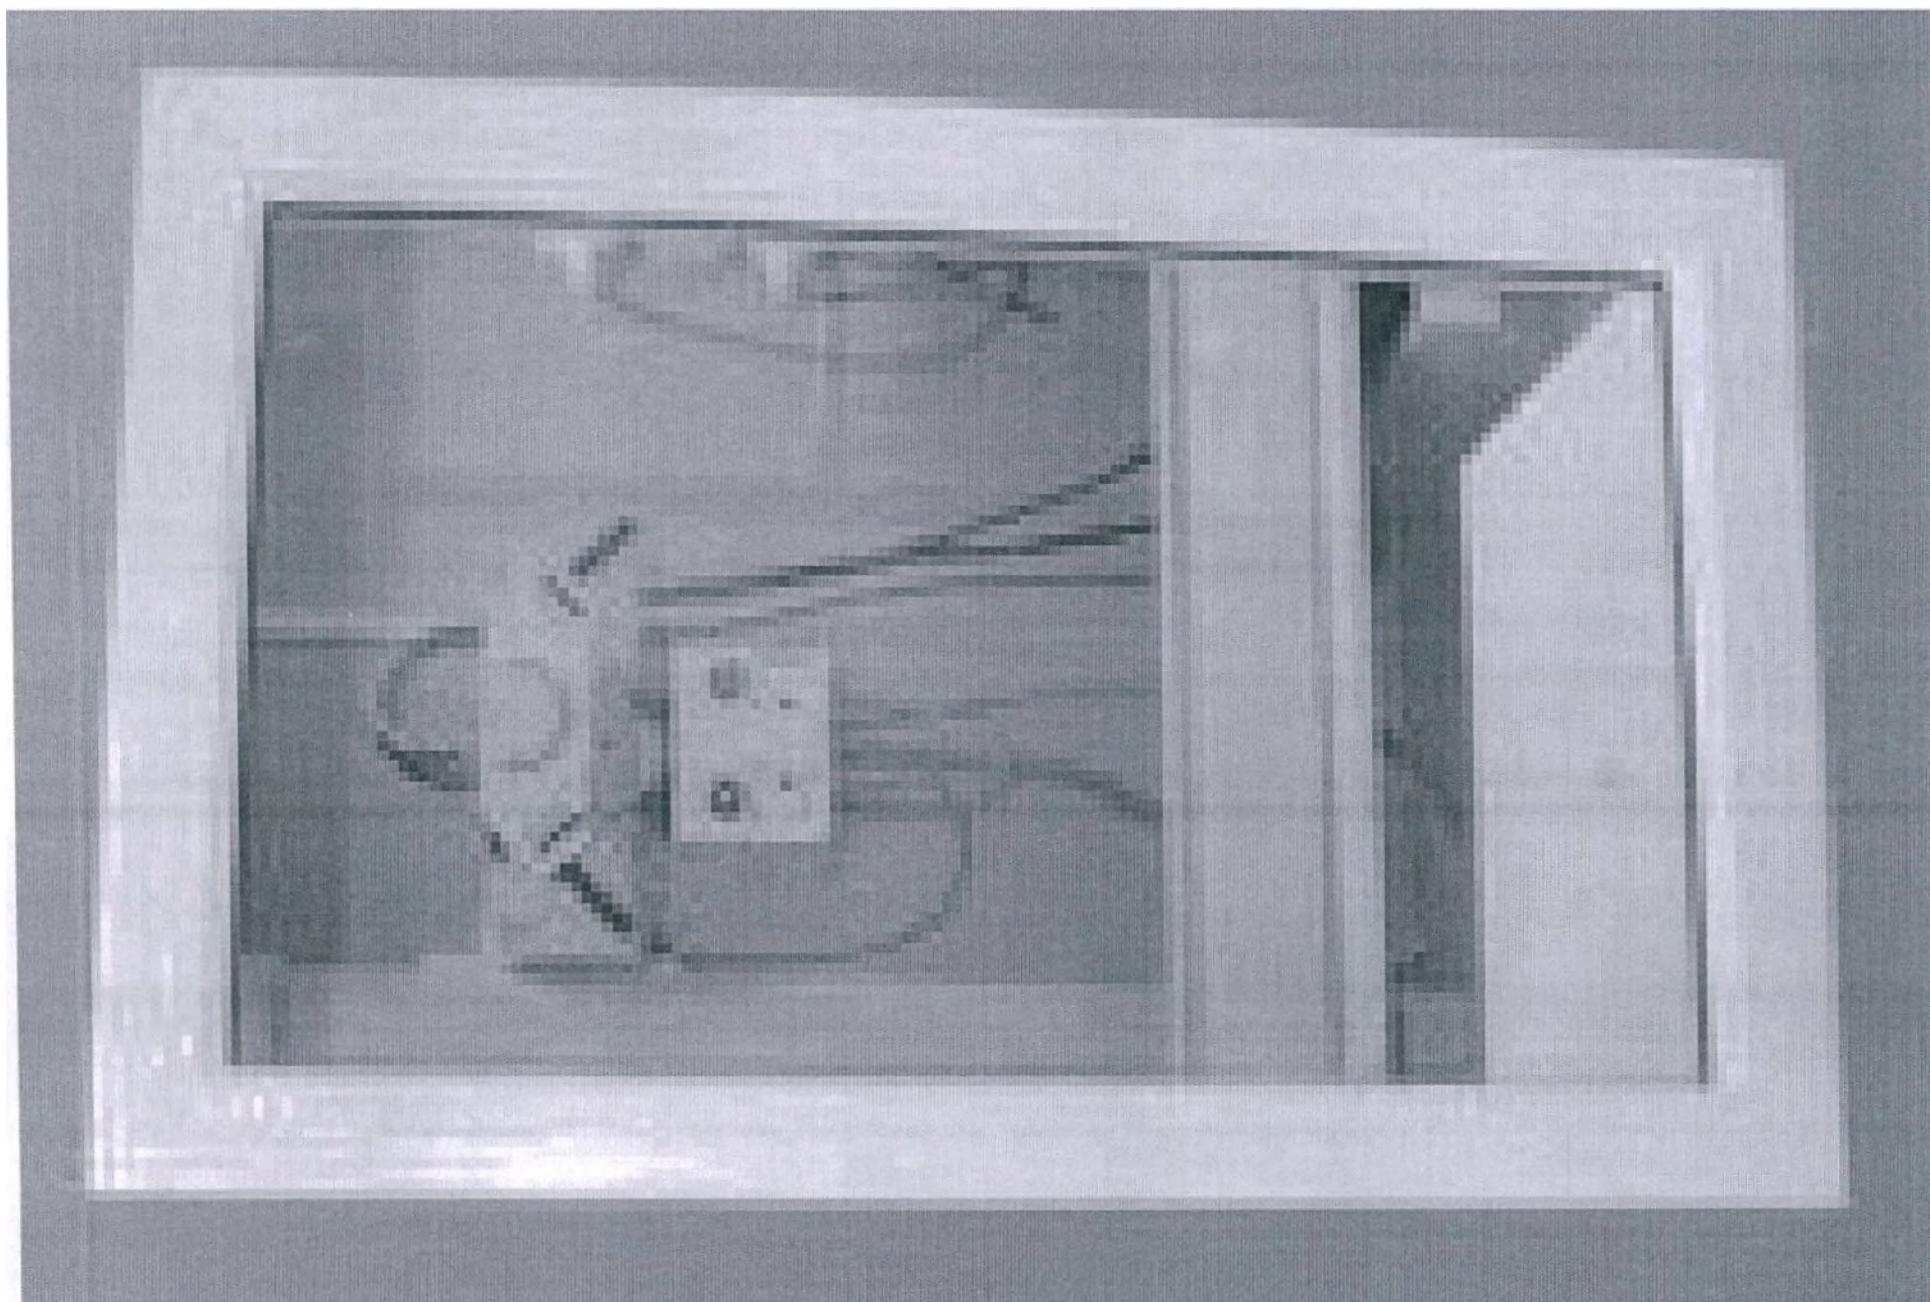

17. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004 производства ЗАО «РЕНЕКС», Российская Федерация (РУ № ФСР 2008/03184);




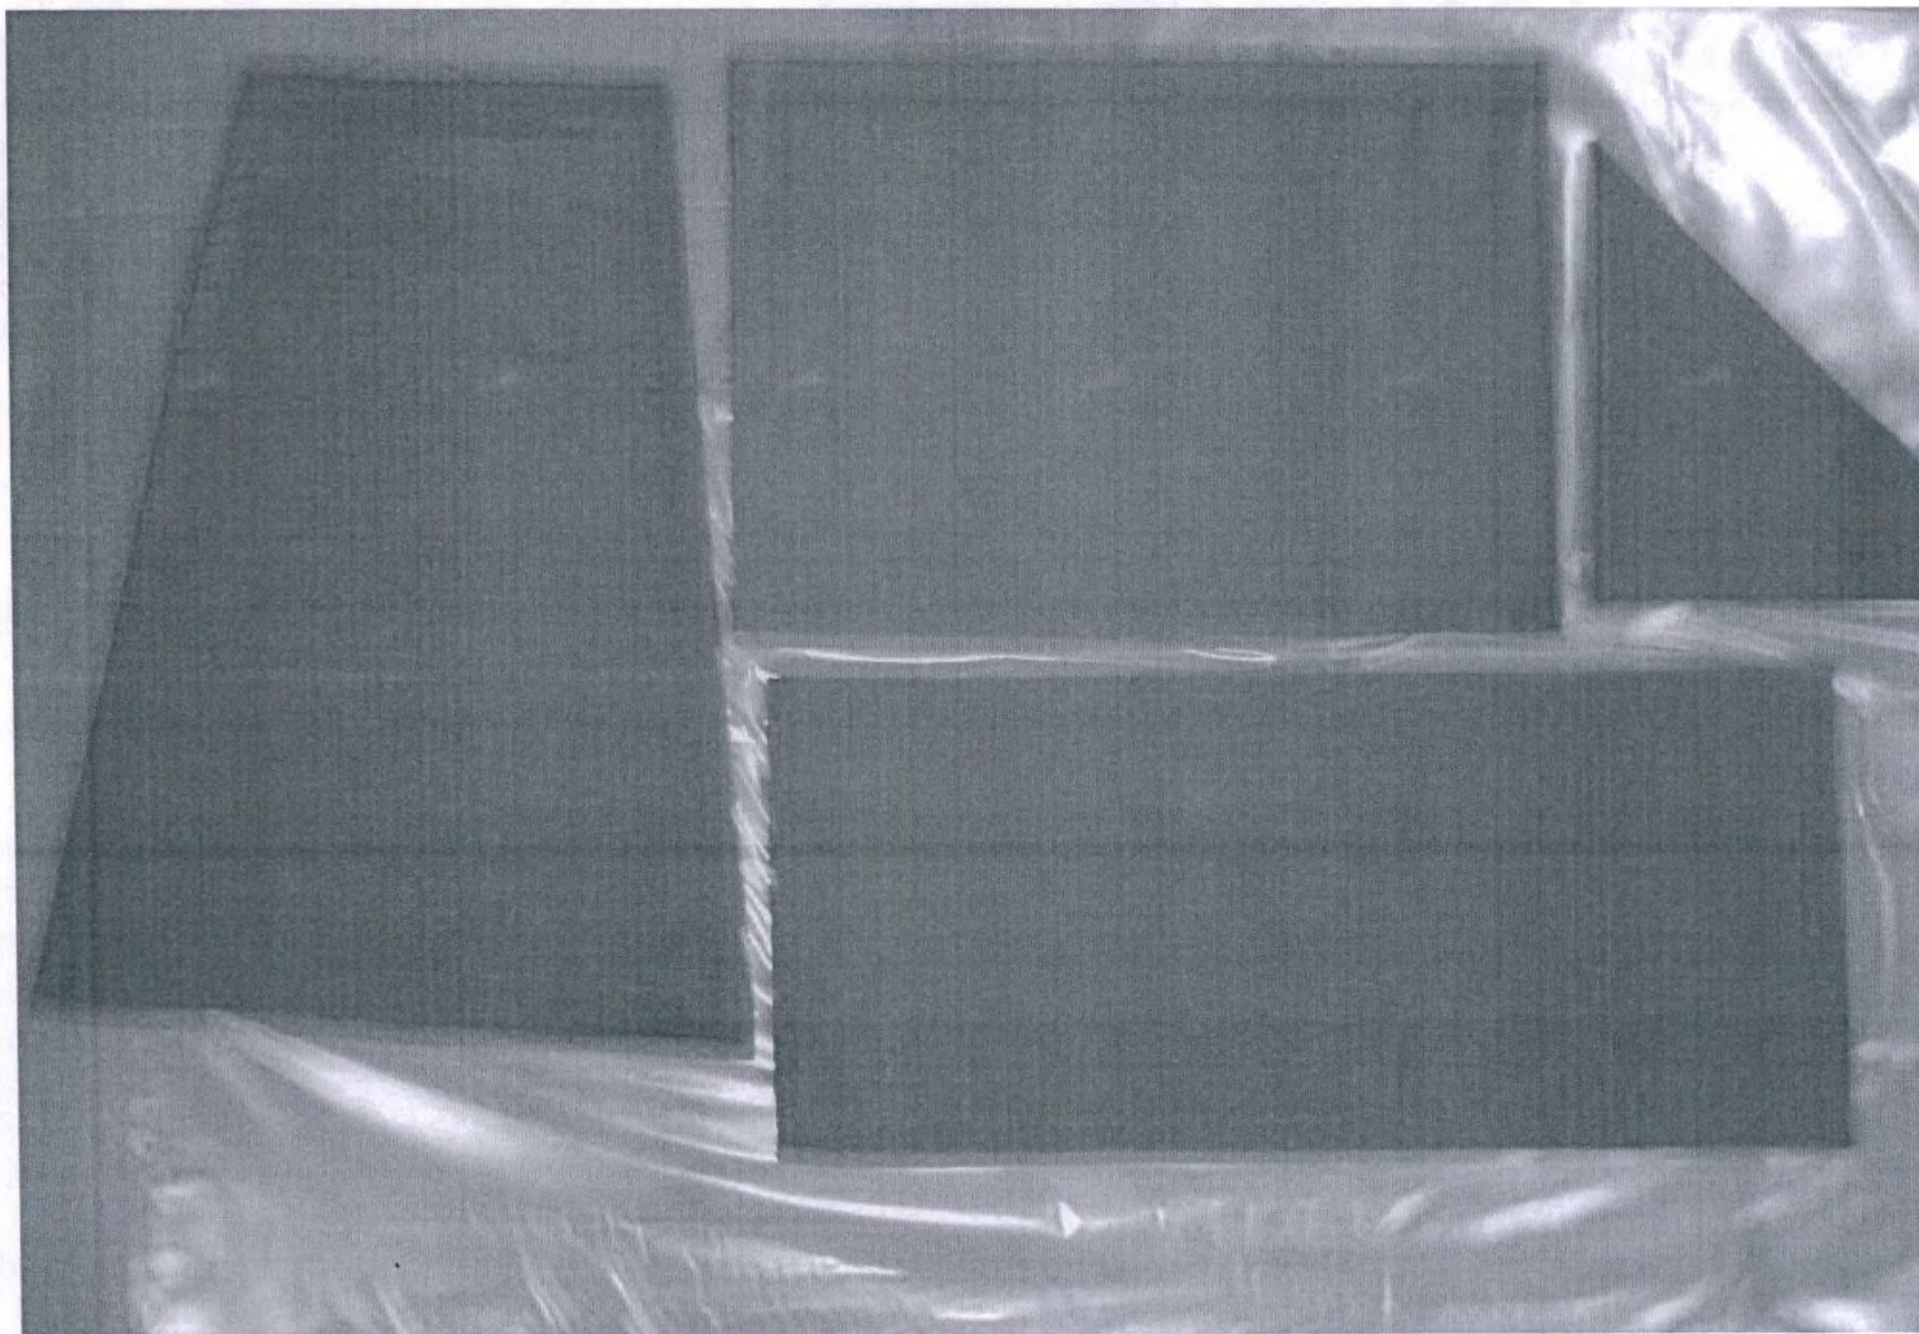

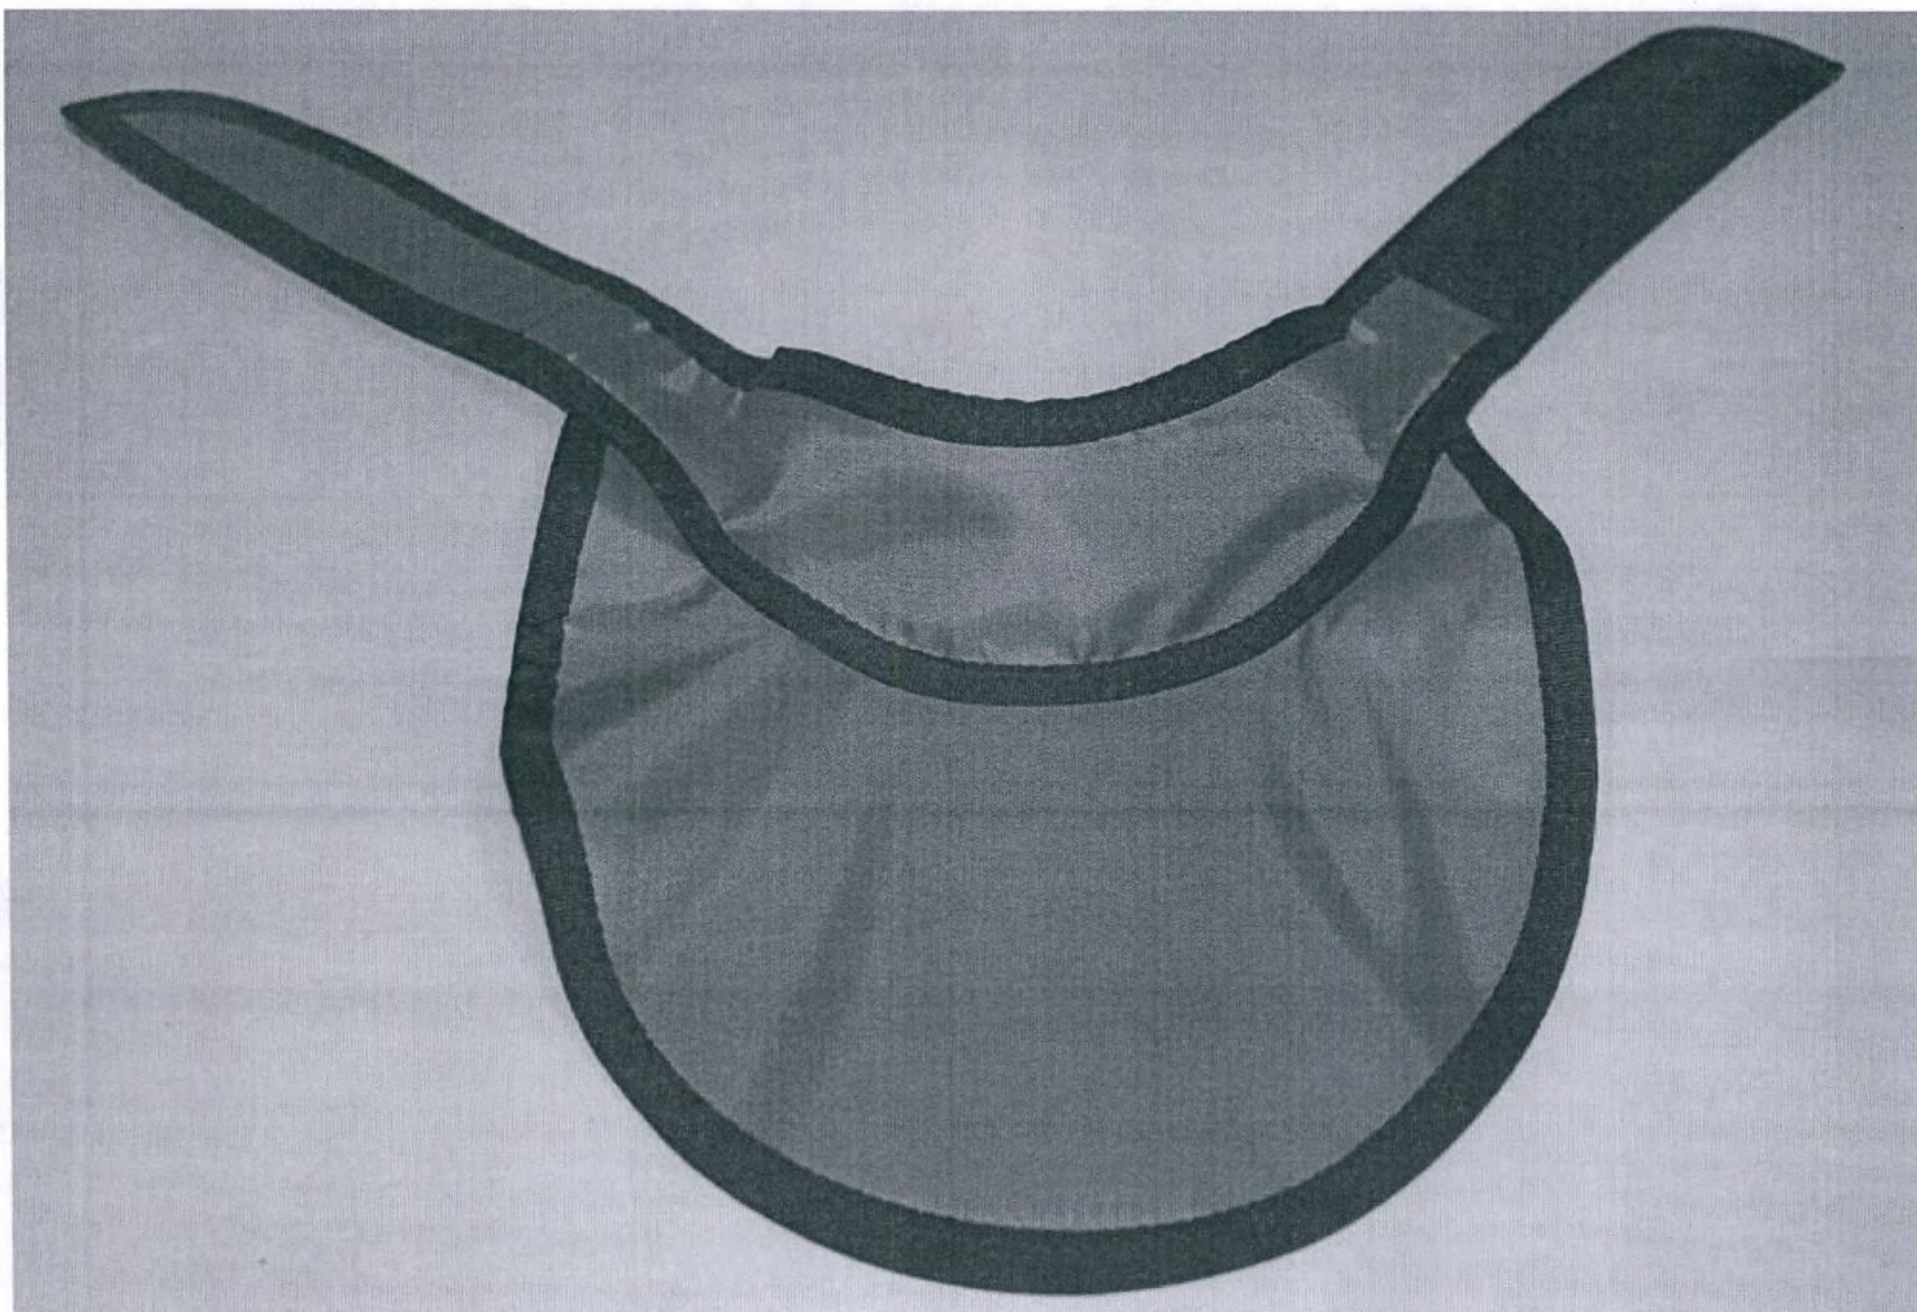



или комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006 производства ООО "МП НПФ «Гаммамед-П», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/10727);



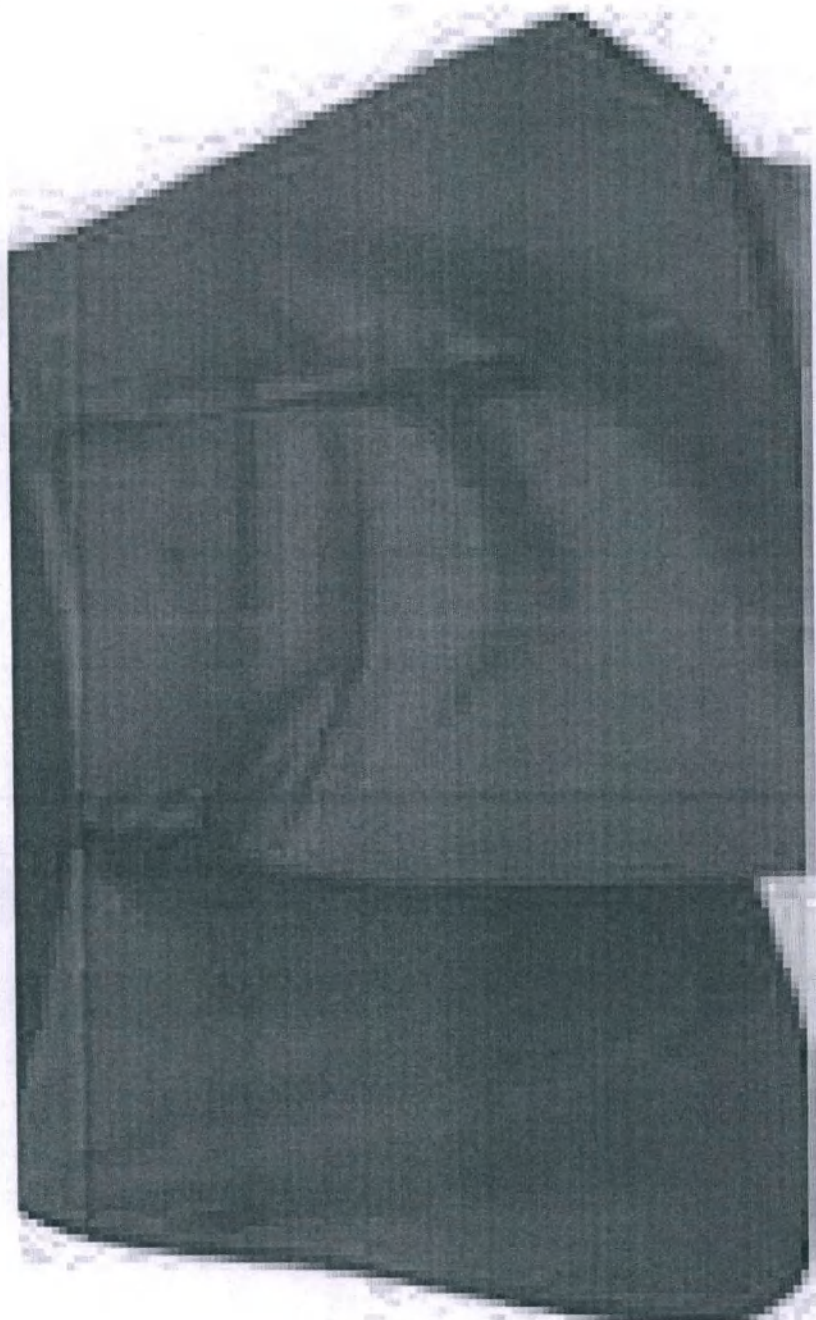


или комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001 производства ООО «Рентген-Комплект», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/10477).

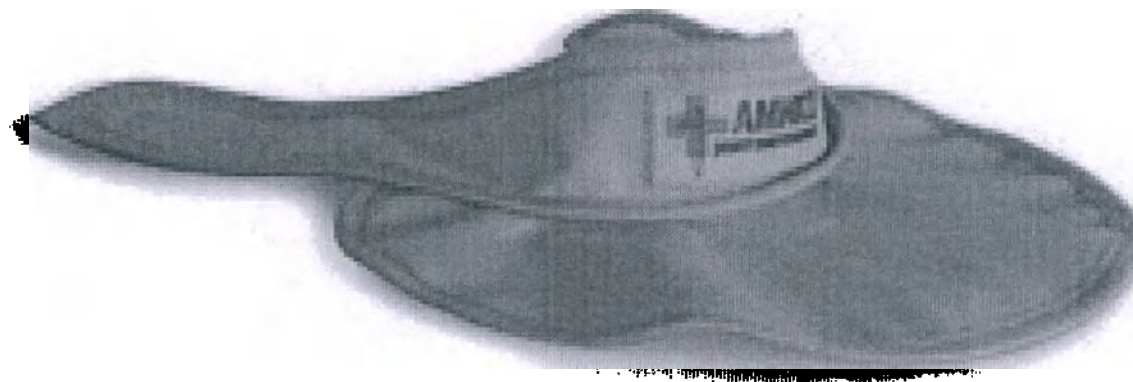


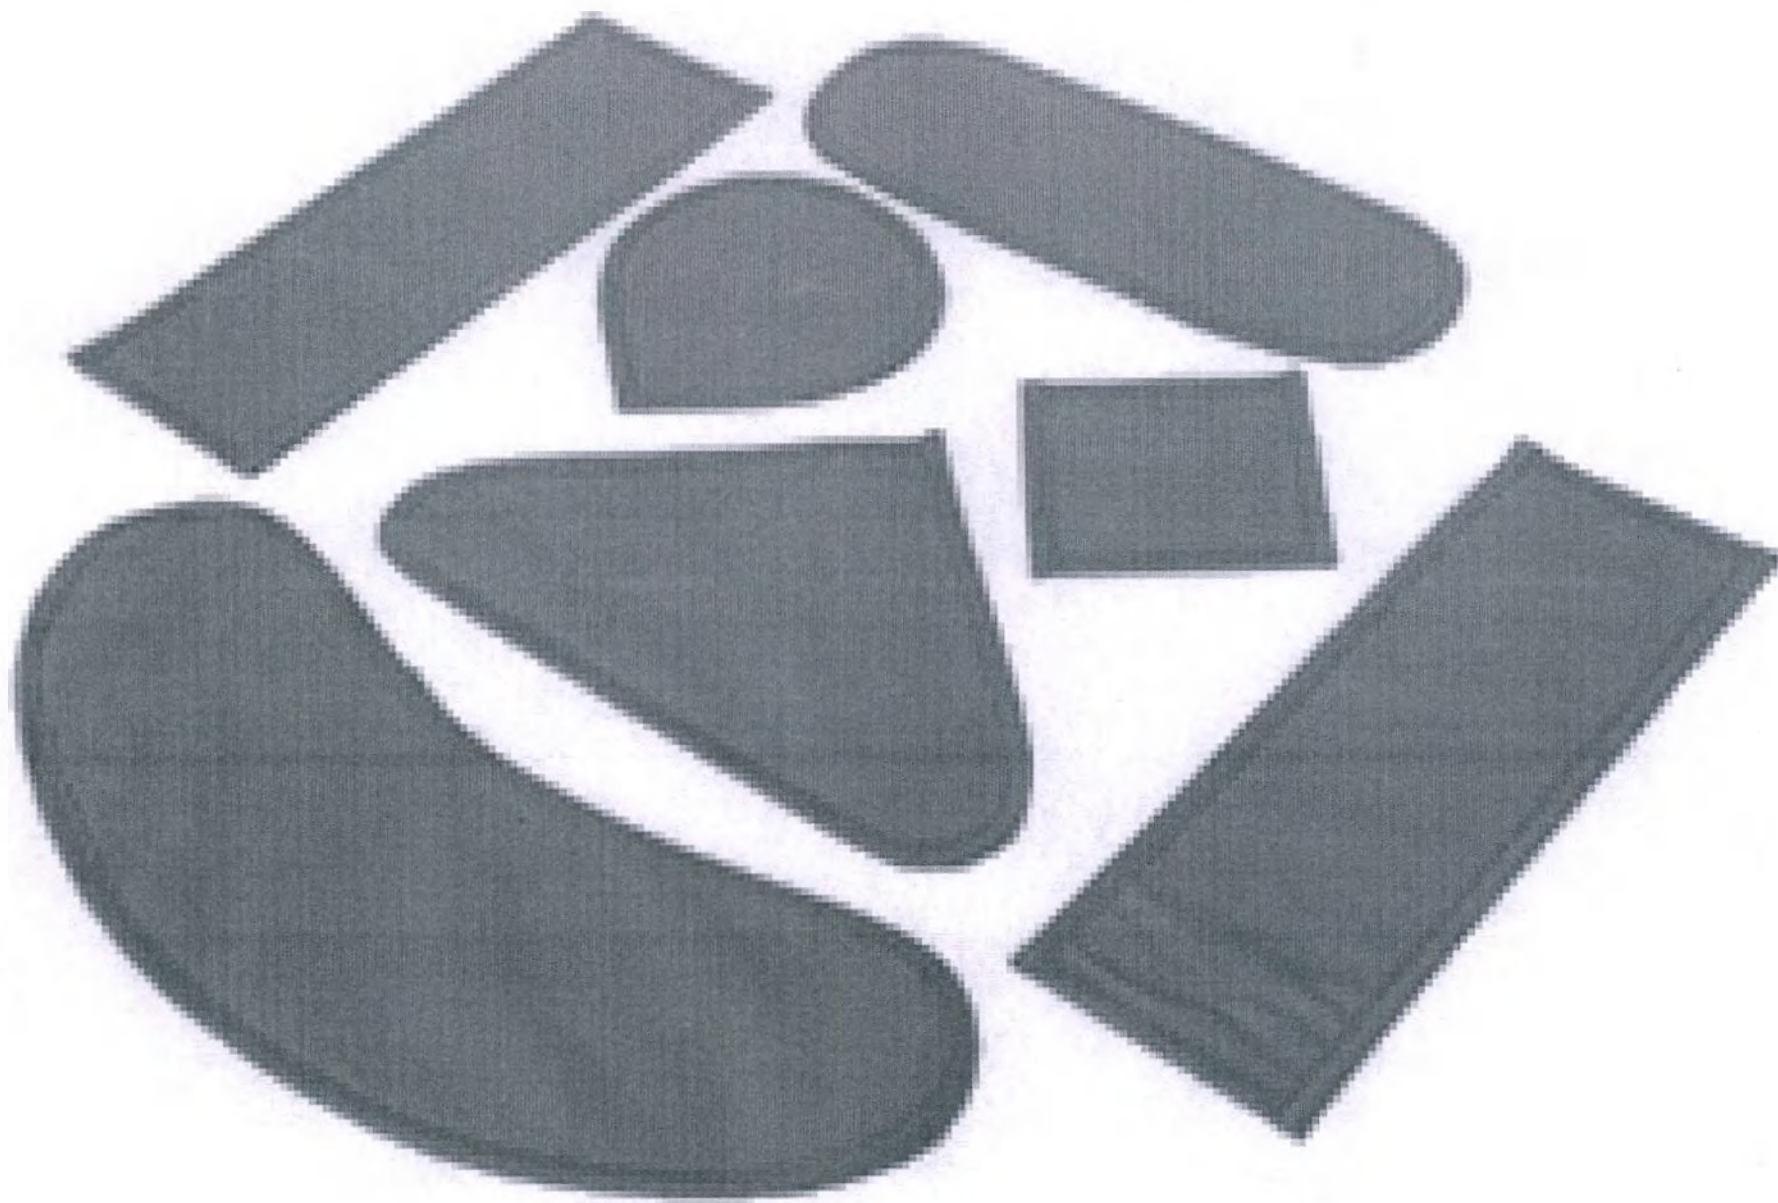



18. Стойка для рентгенографии IMX производства Imago Radiology S.r.l. Италия;

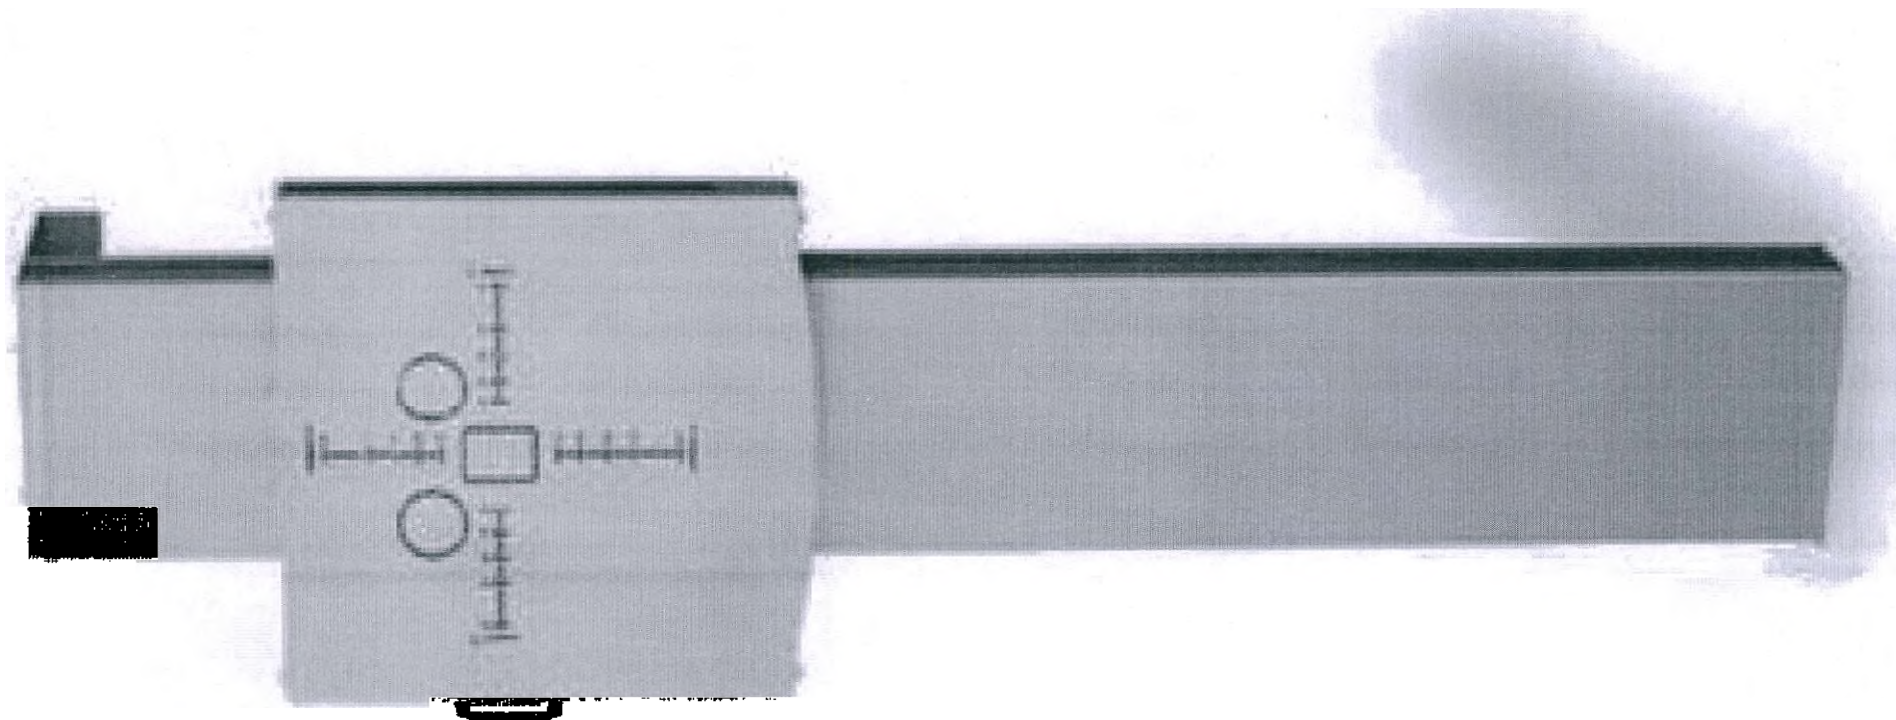


или Millenium производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания;

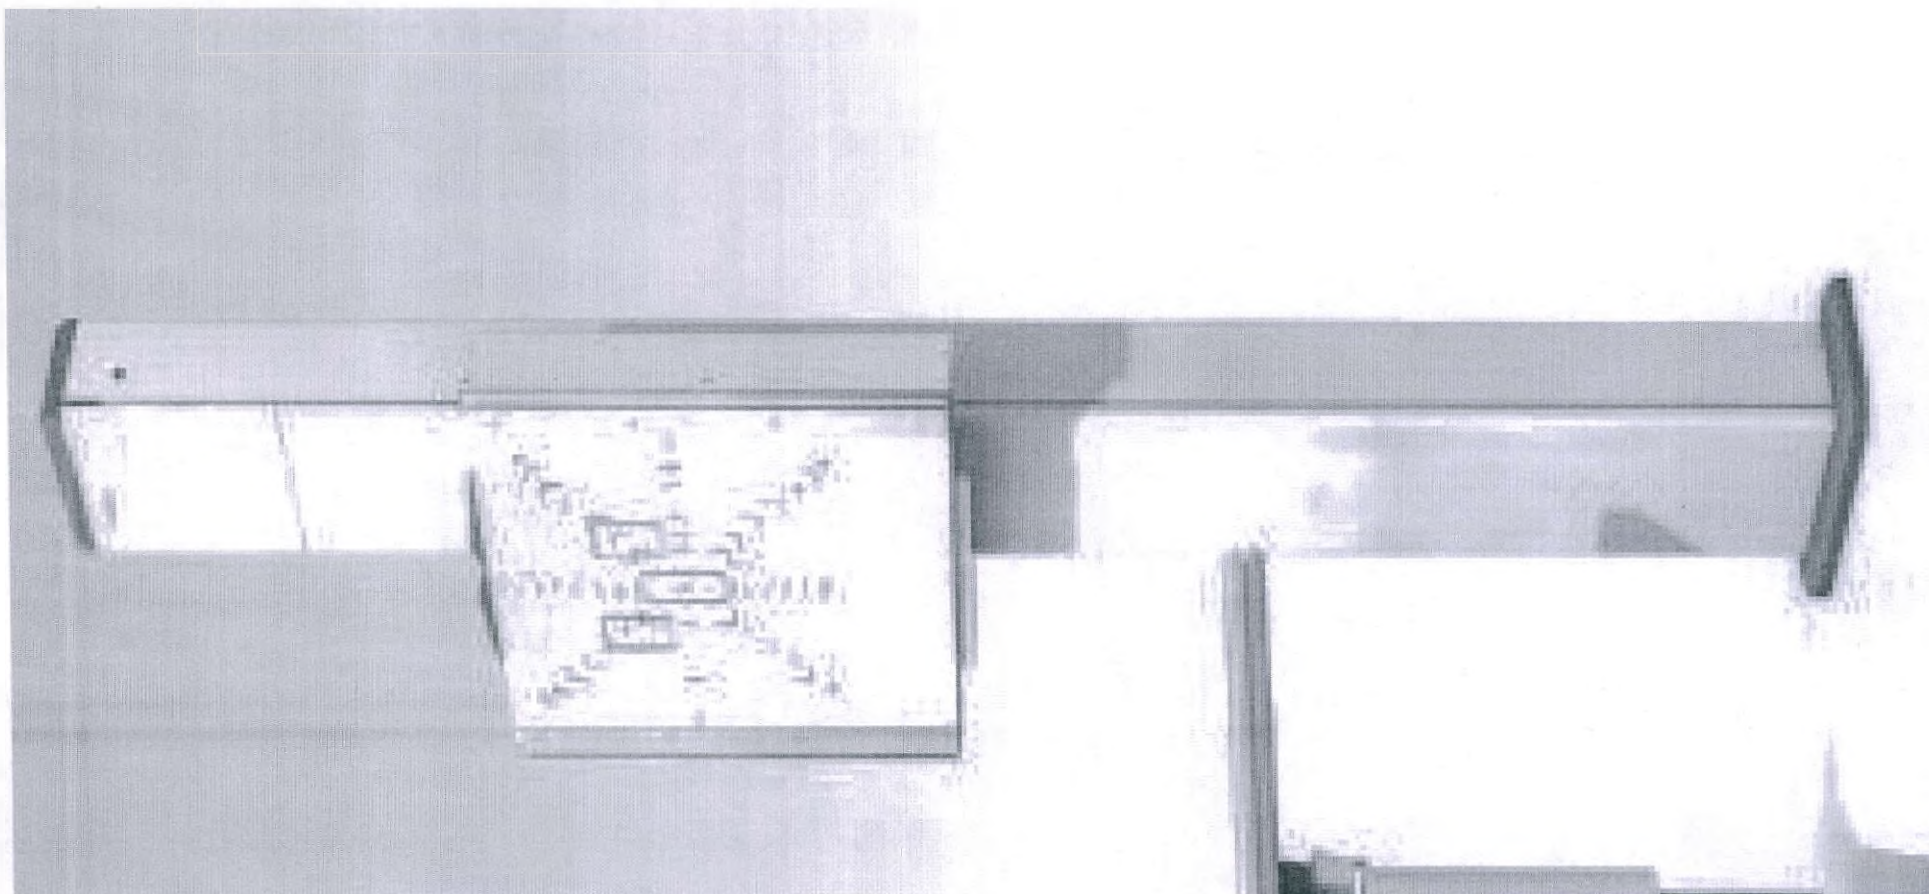


или RS производства General Medical Merate SPA (GMM) Италия;

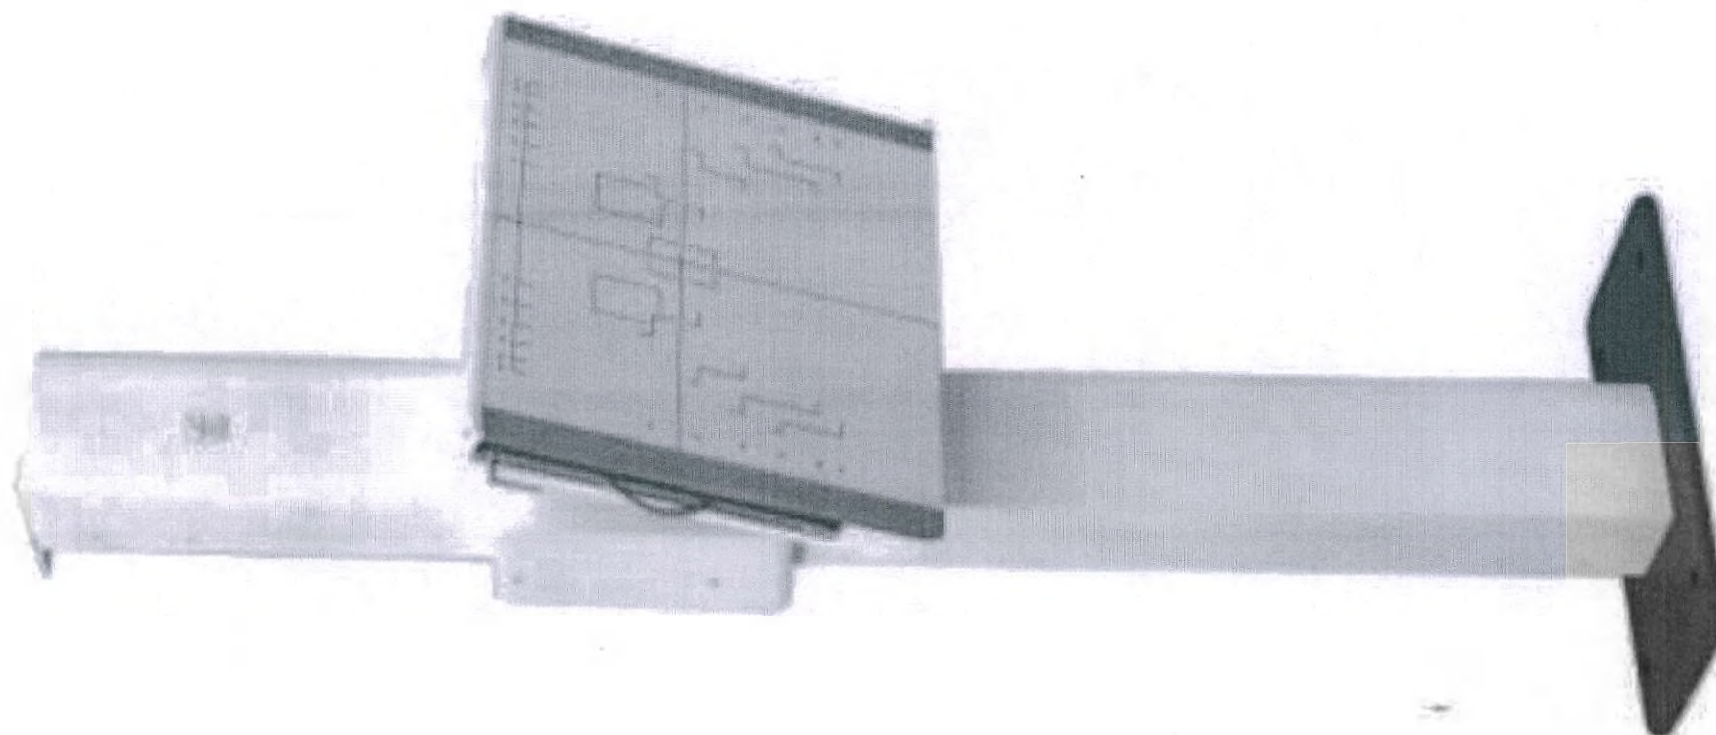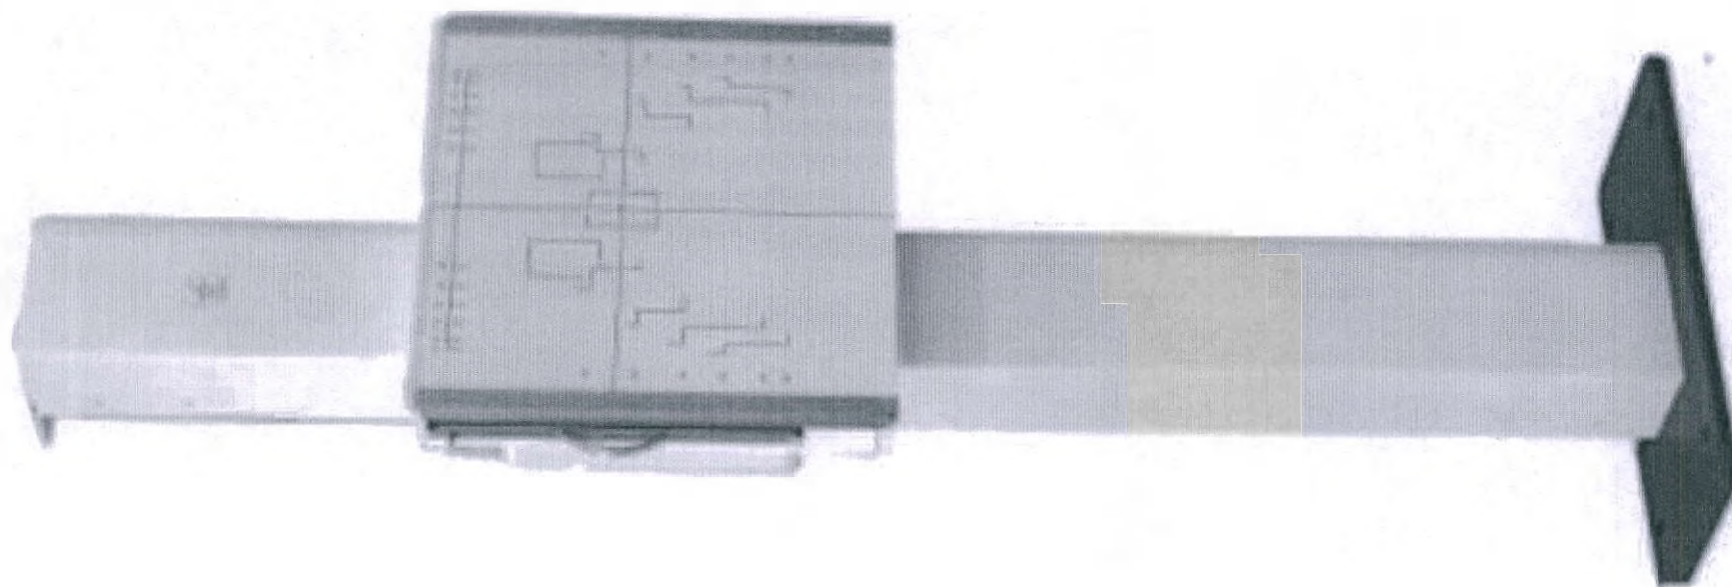


или АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

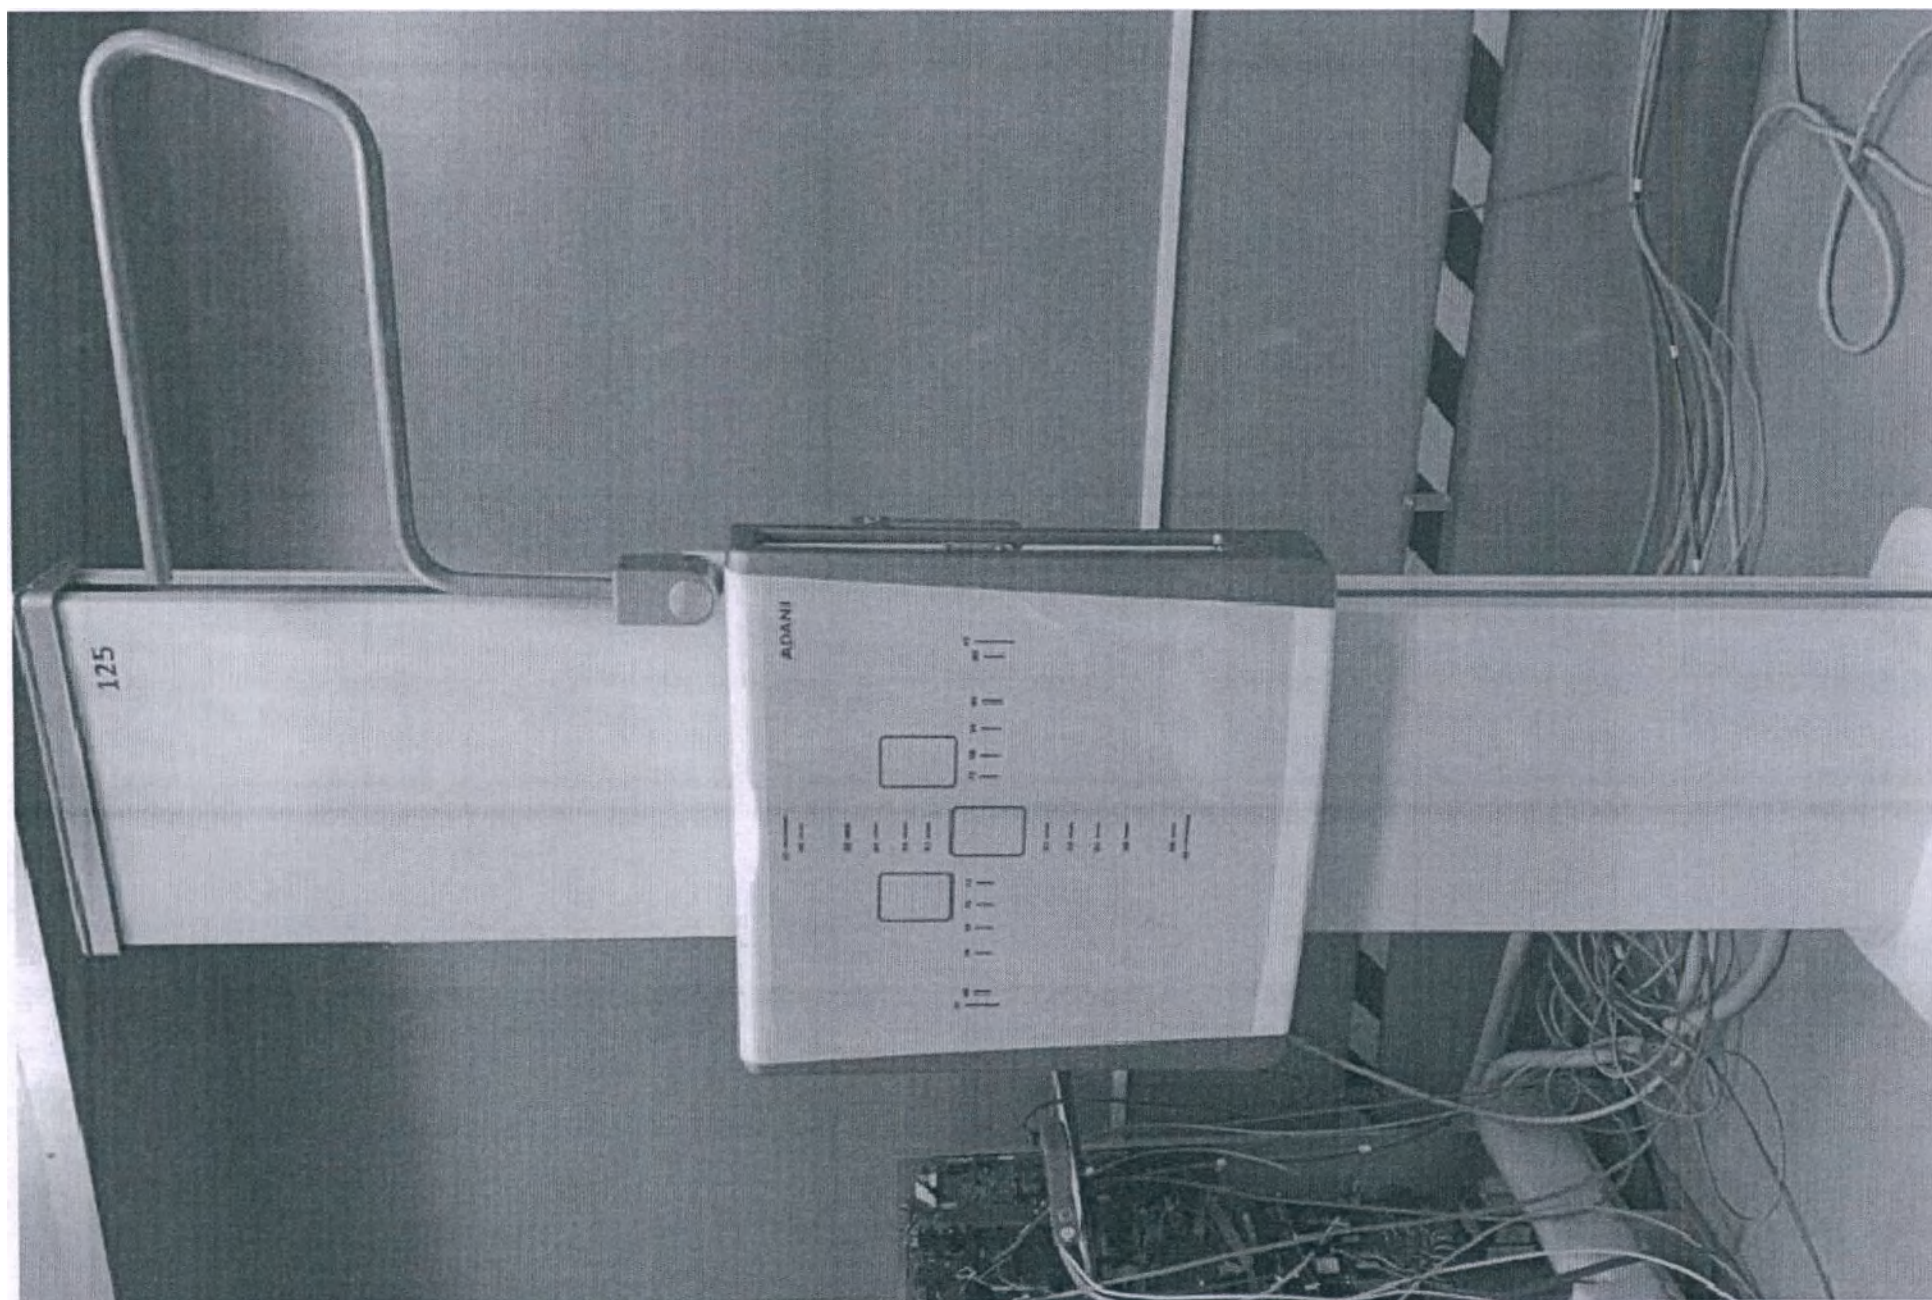


или производства Diagnostic Medical System Apelem, Франция;

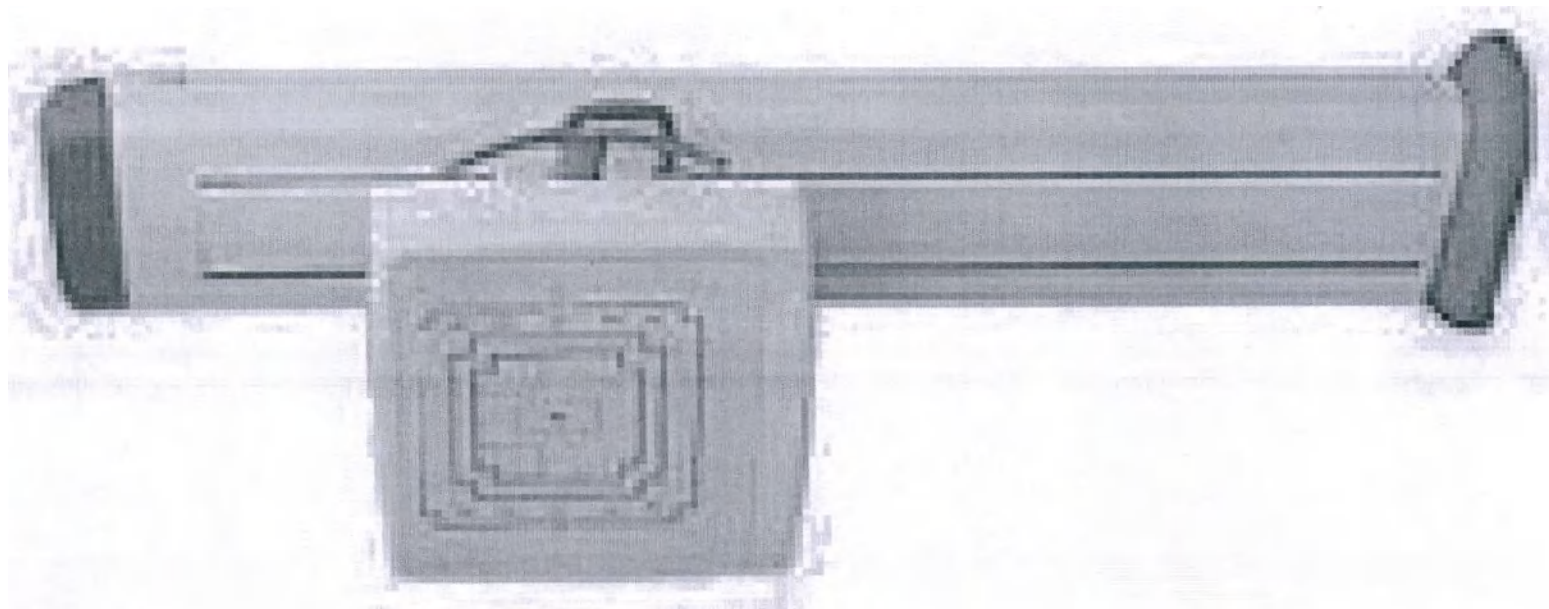


или WS производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

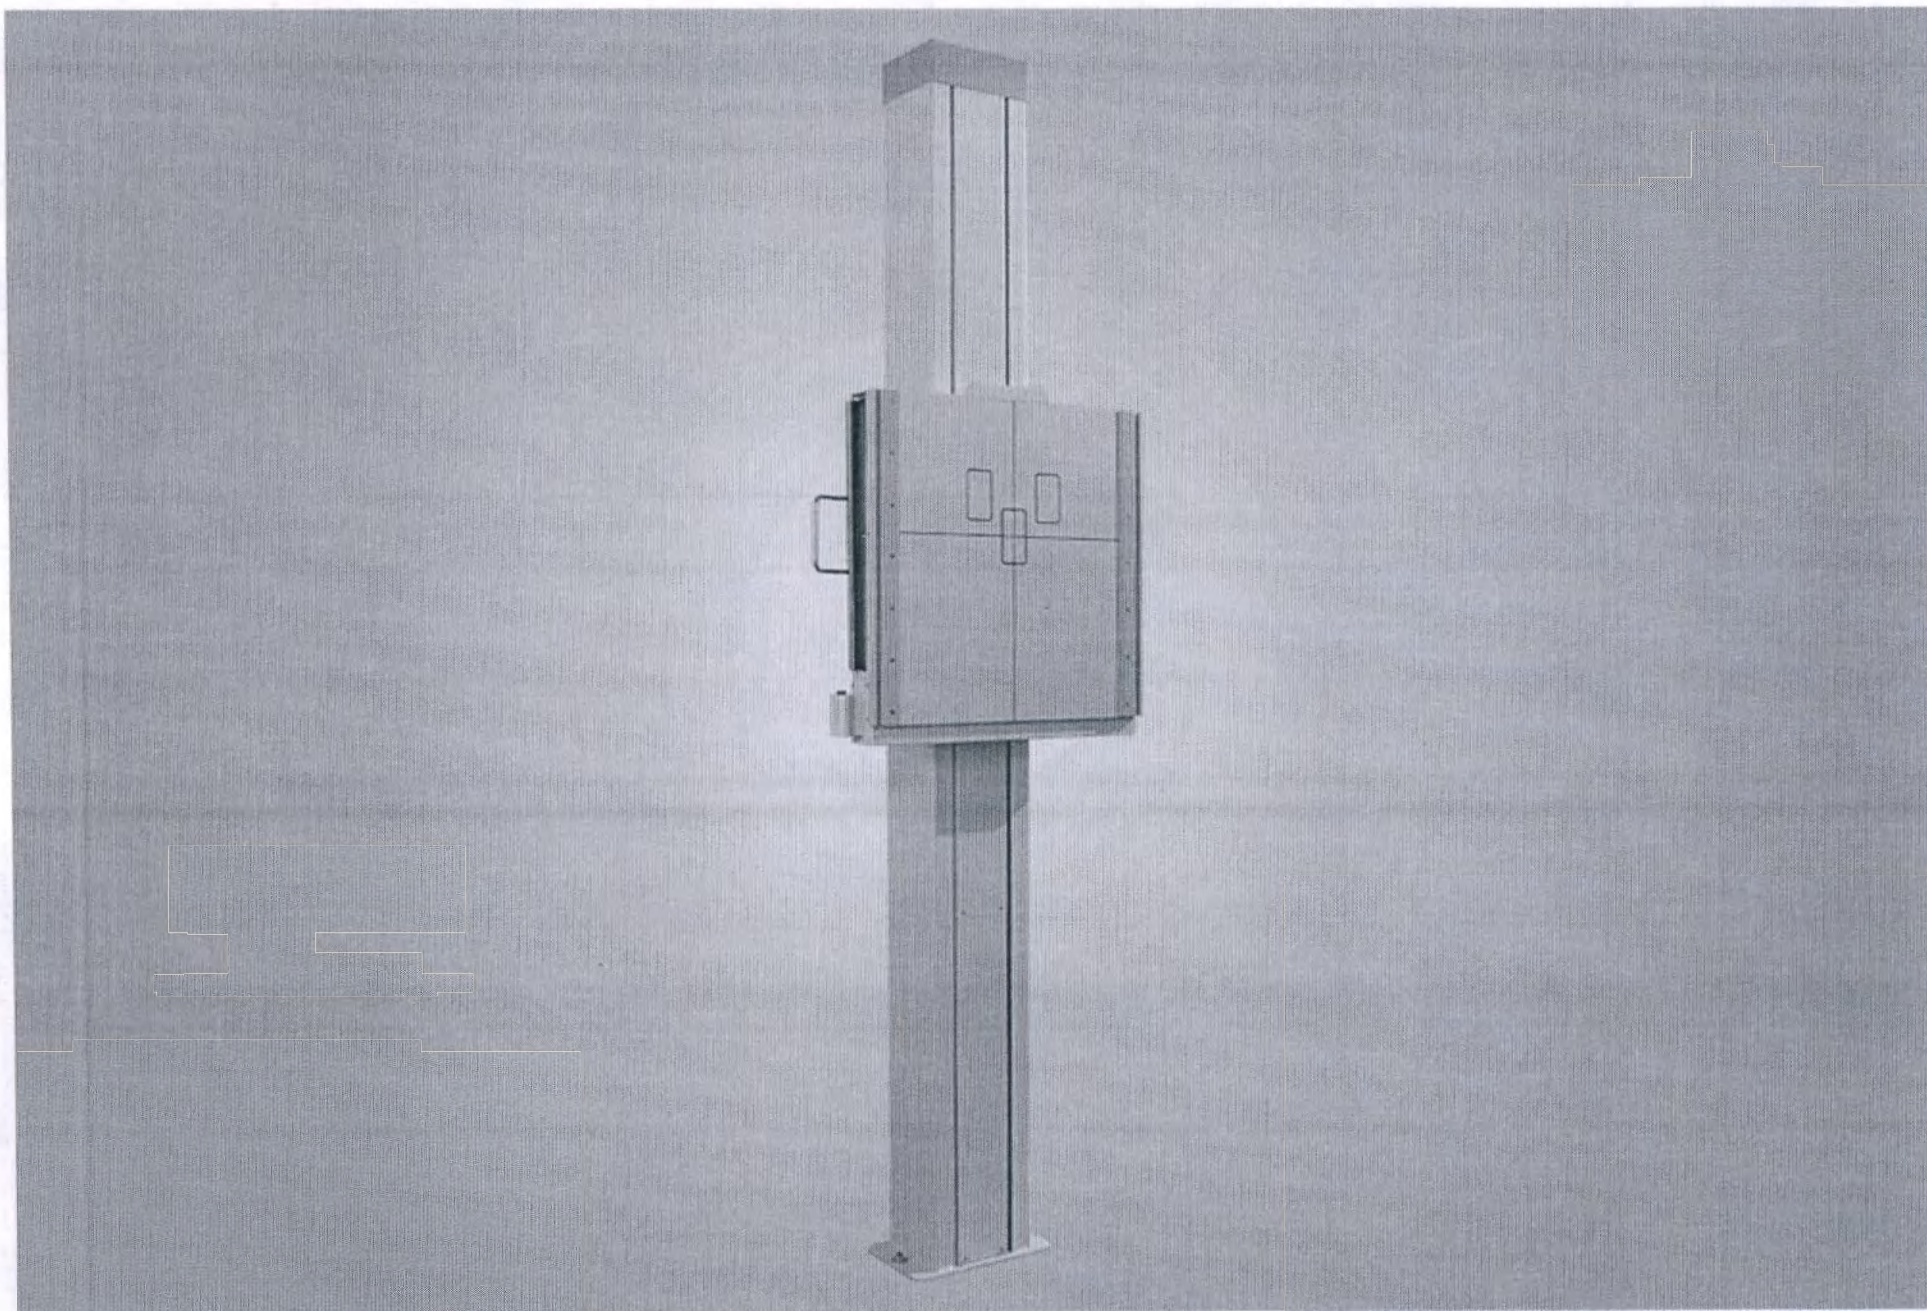

19. Камера ПЗС N производства Nical SPA, Италия;

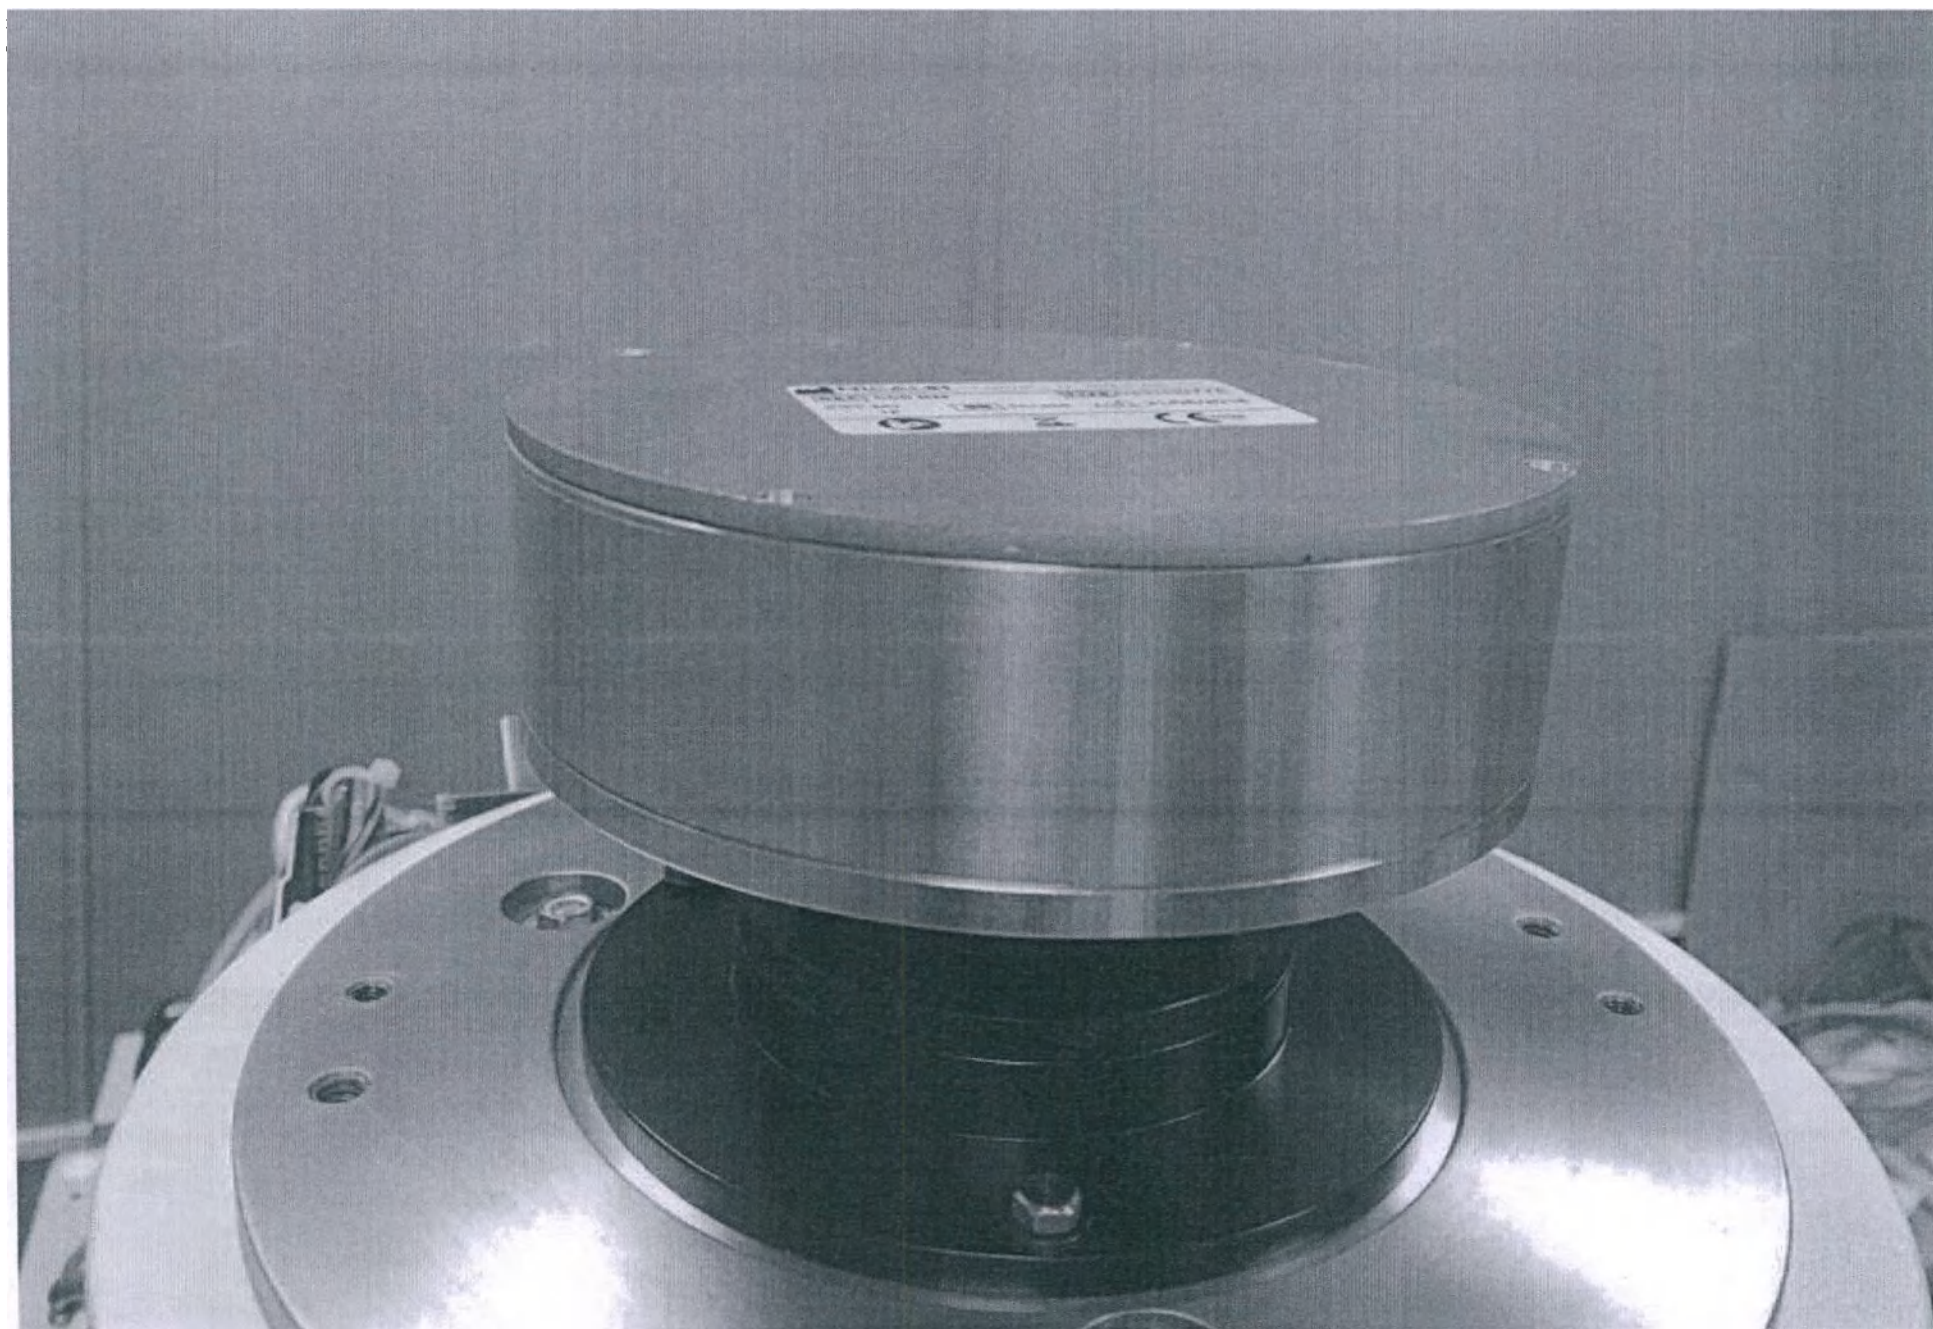


или Pearl производства Adimec Advanced Image Systems BV, Нидерланды;

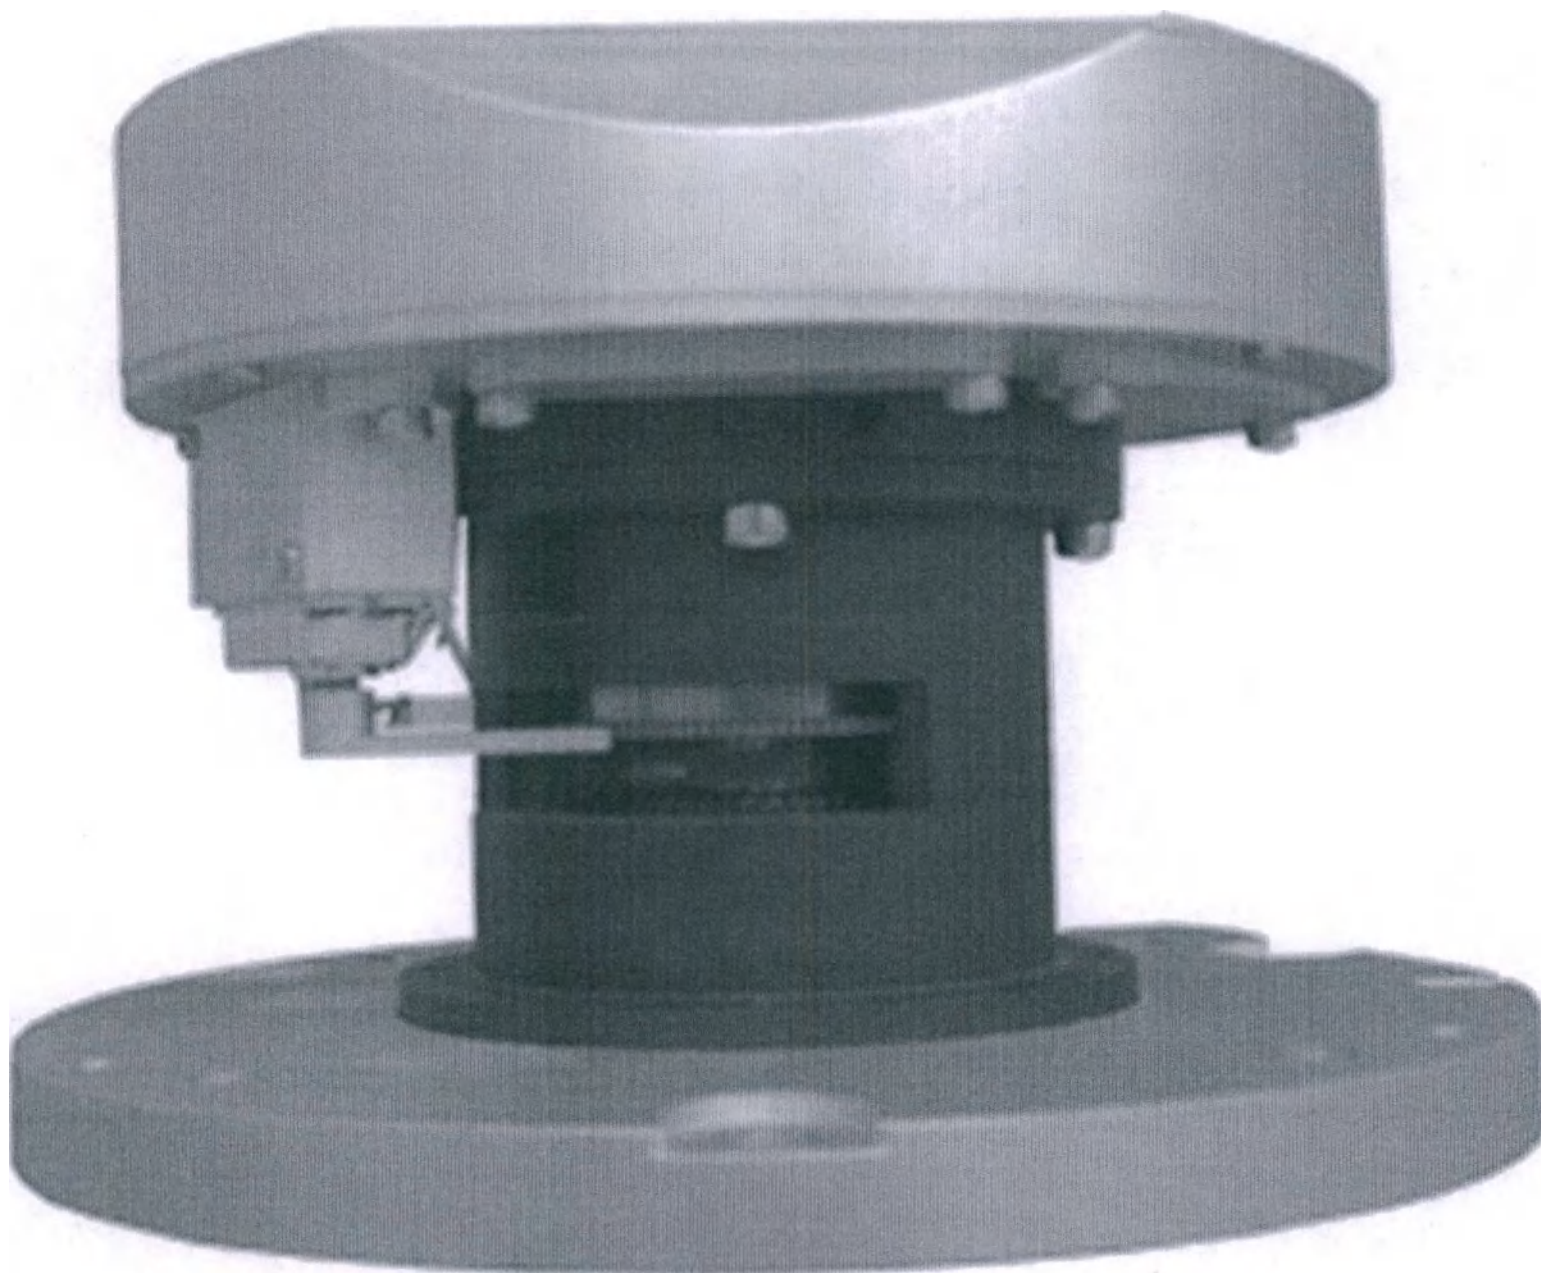


или ТН производства Thales Electron Devices SAS, Франция;




или HIDEQ производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

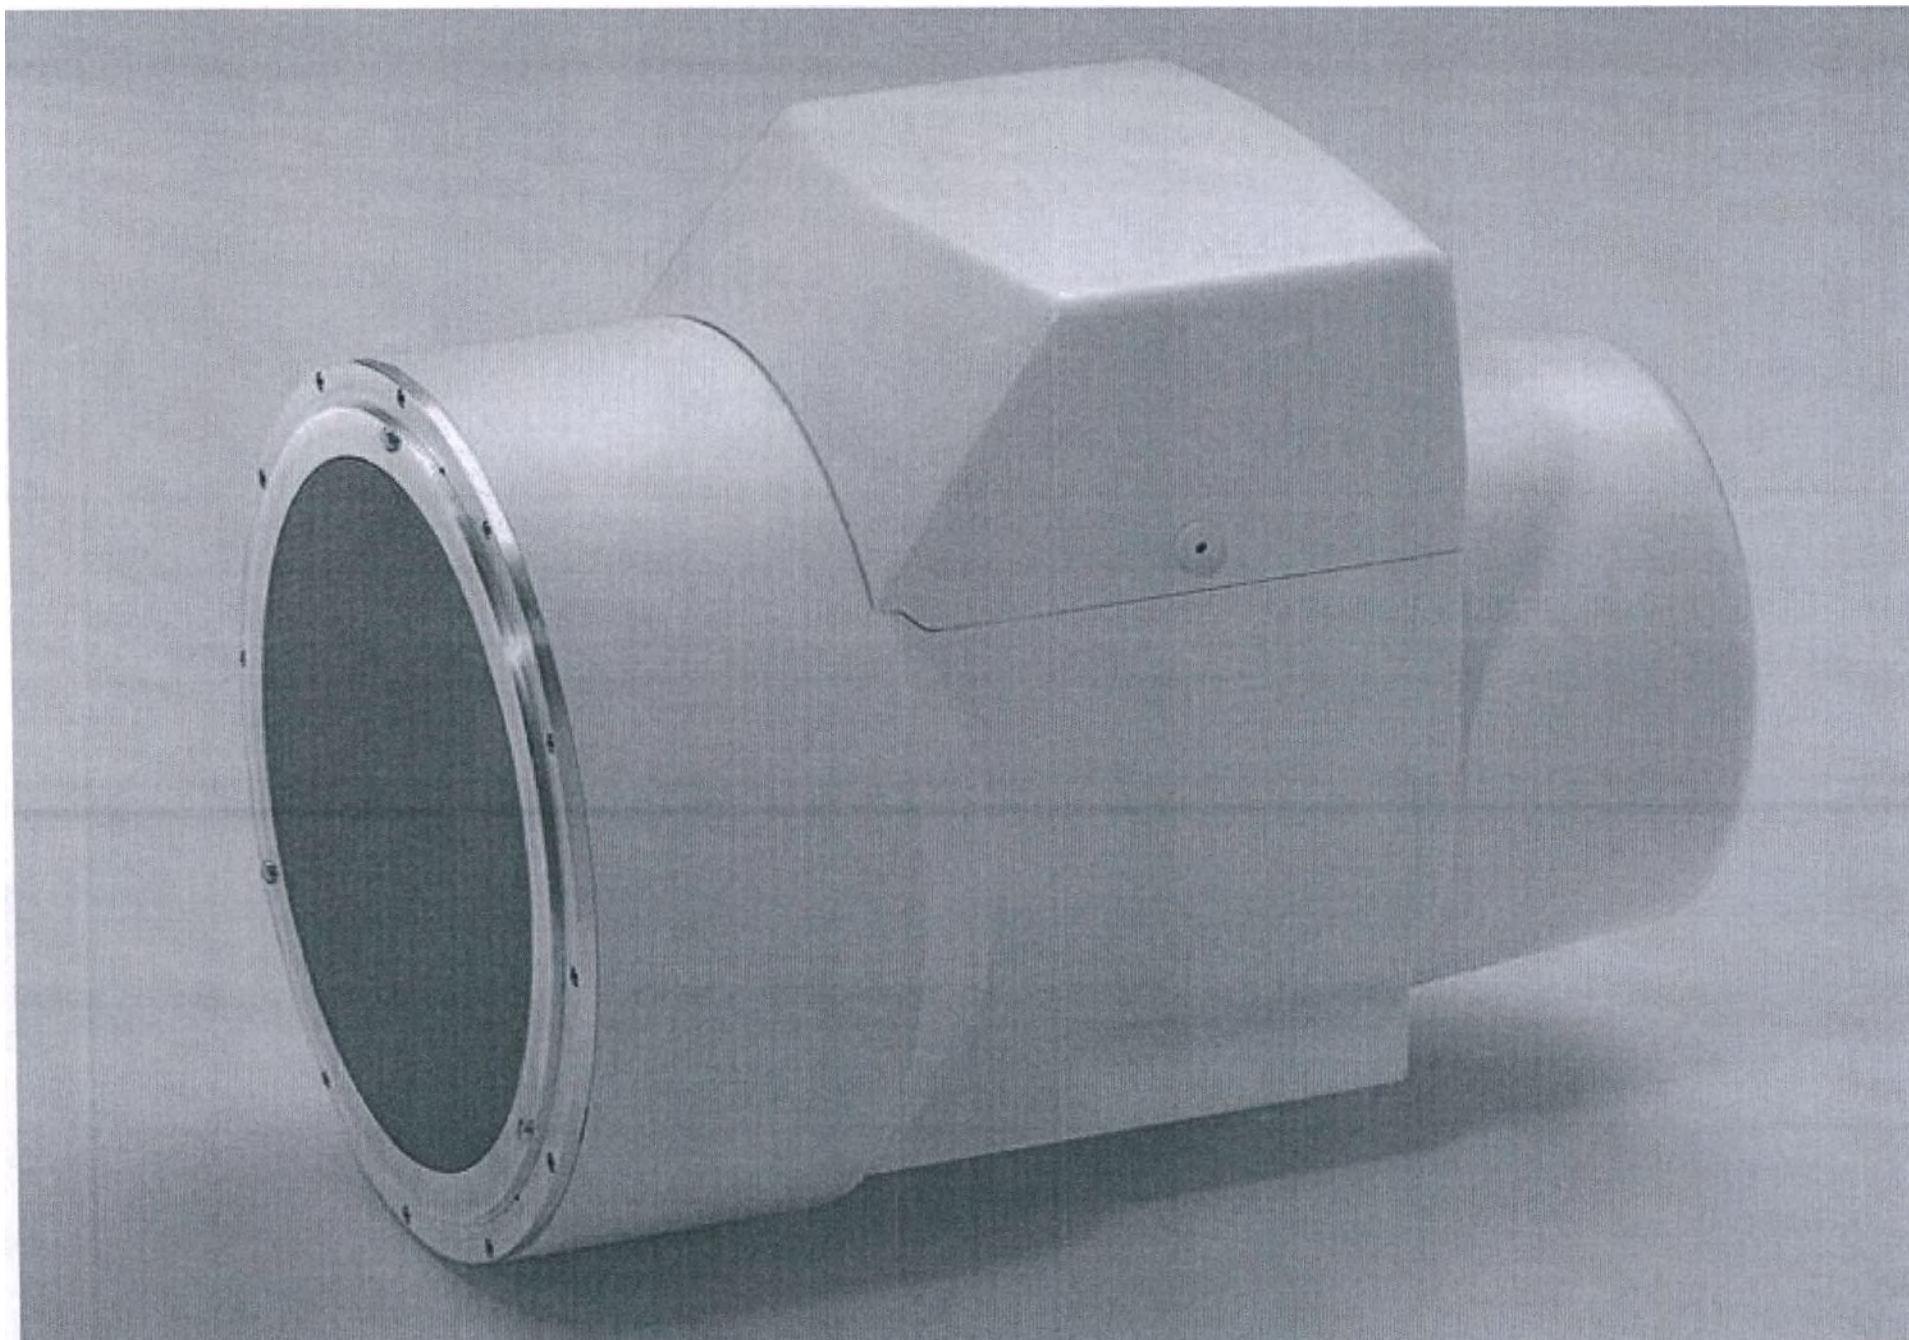


20. Усилитель рентгеновского изображения ТН производства Thales Electron Devices SAS, Франция;

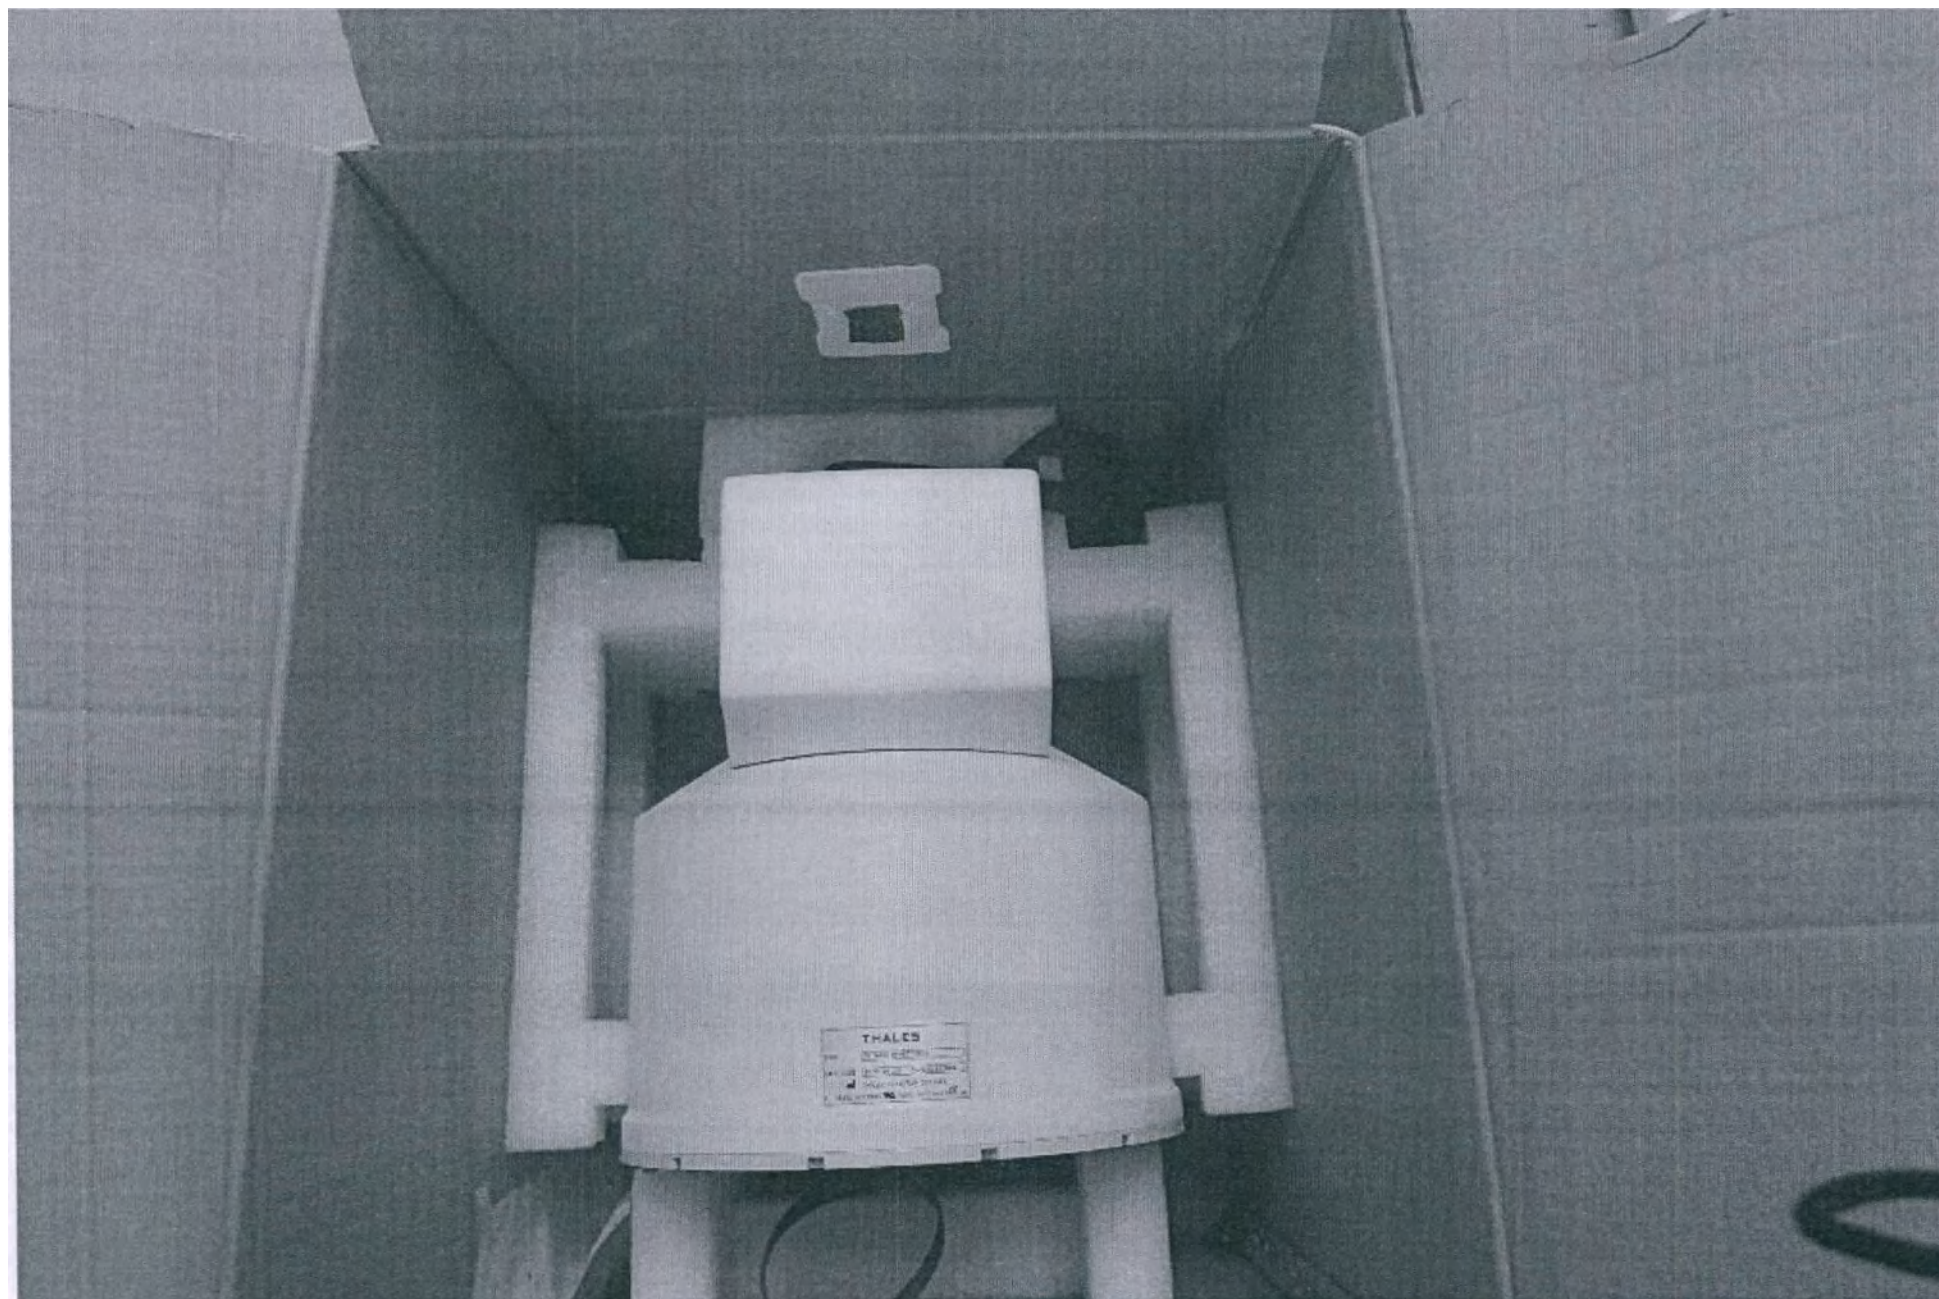


или Е производства Canon Medical System Corporation, Япония;

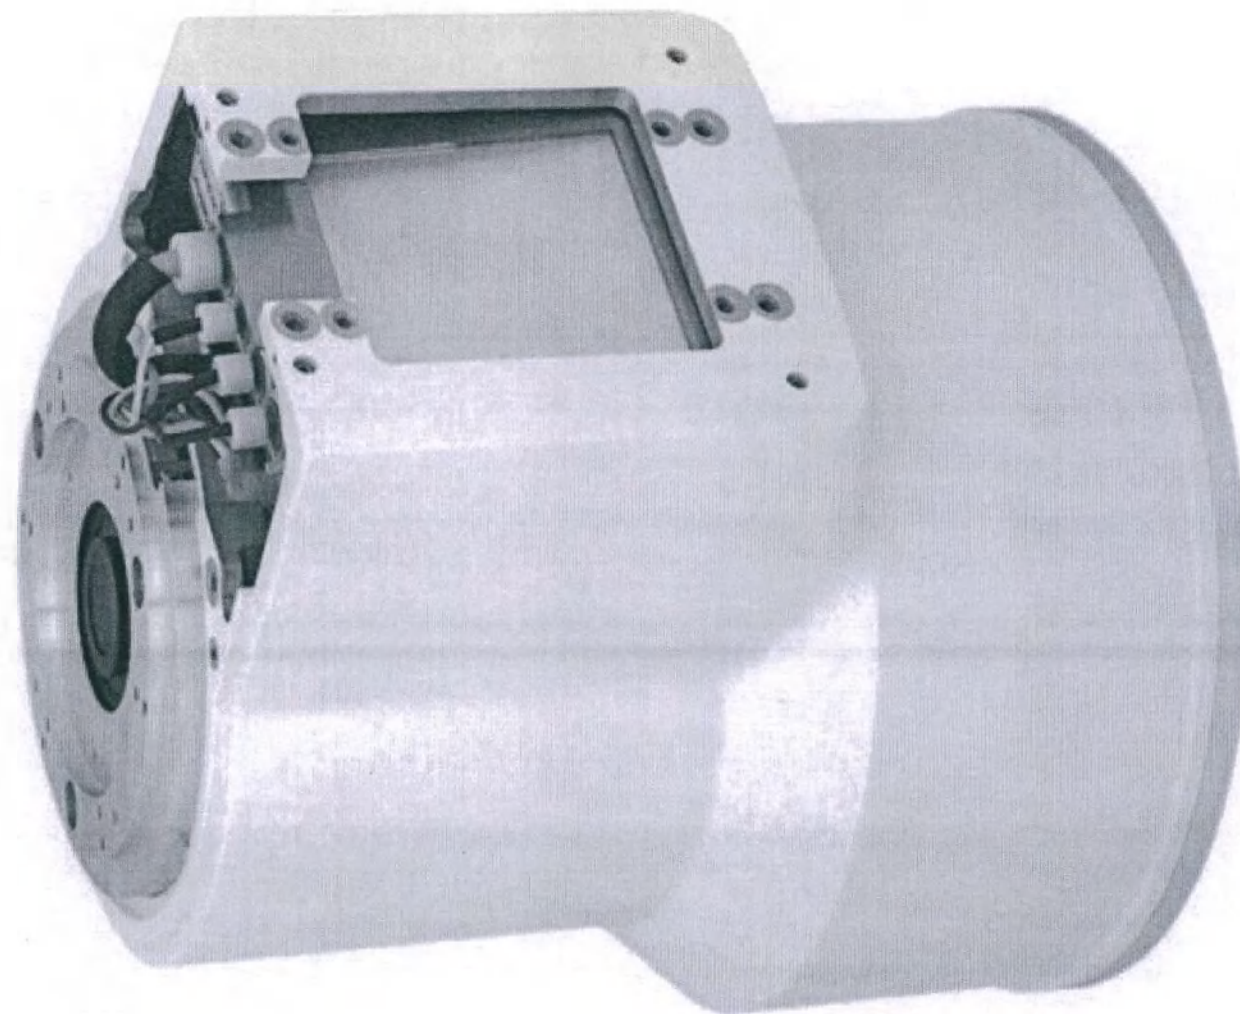


или устройства усиления и формирования рентгеновского изображения HIDEQ производства Siemens Healthcare GmbH, Германия (РУ № ФСЗ 2010/06086).

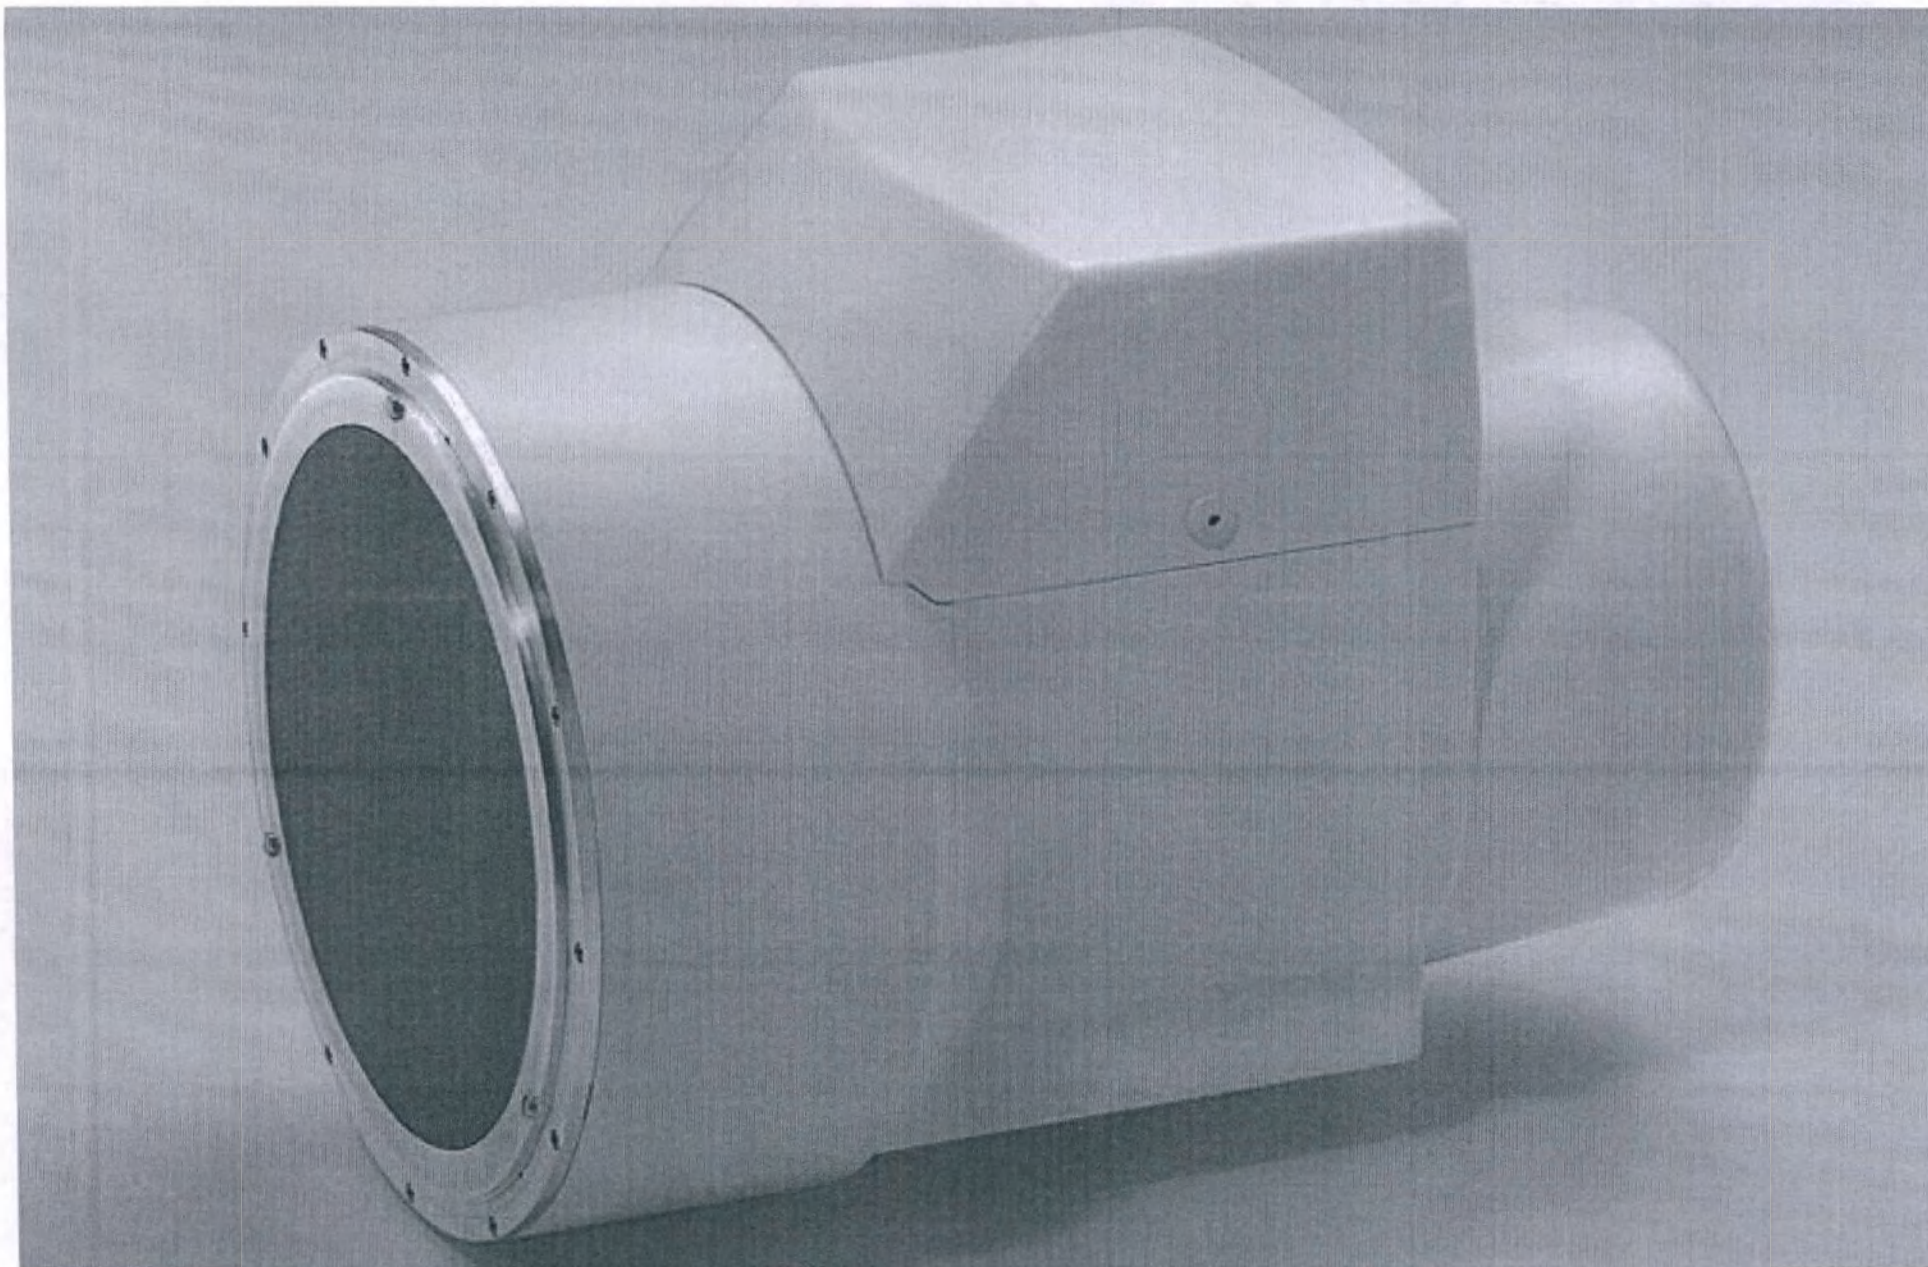


21. Анти-рассеивающая решетка производства JPI Healthcare Co, Ltd, Республика Корея;

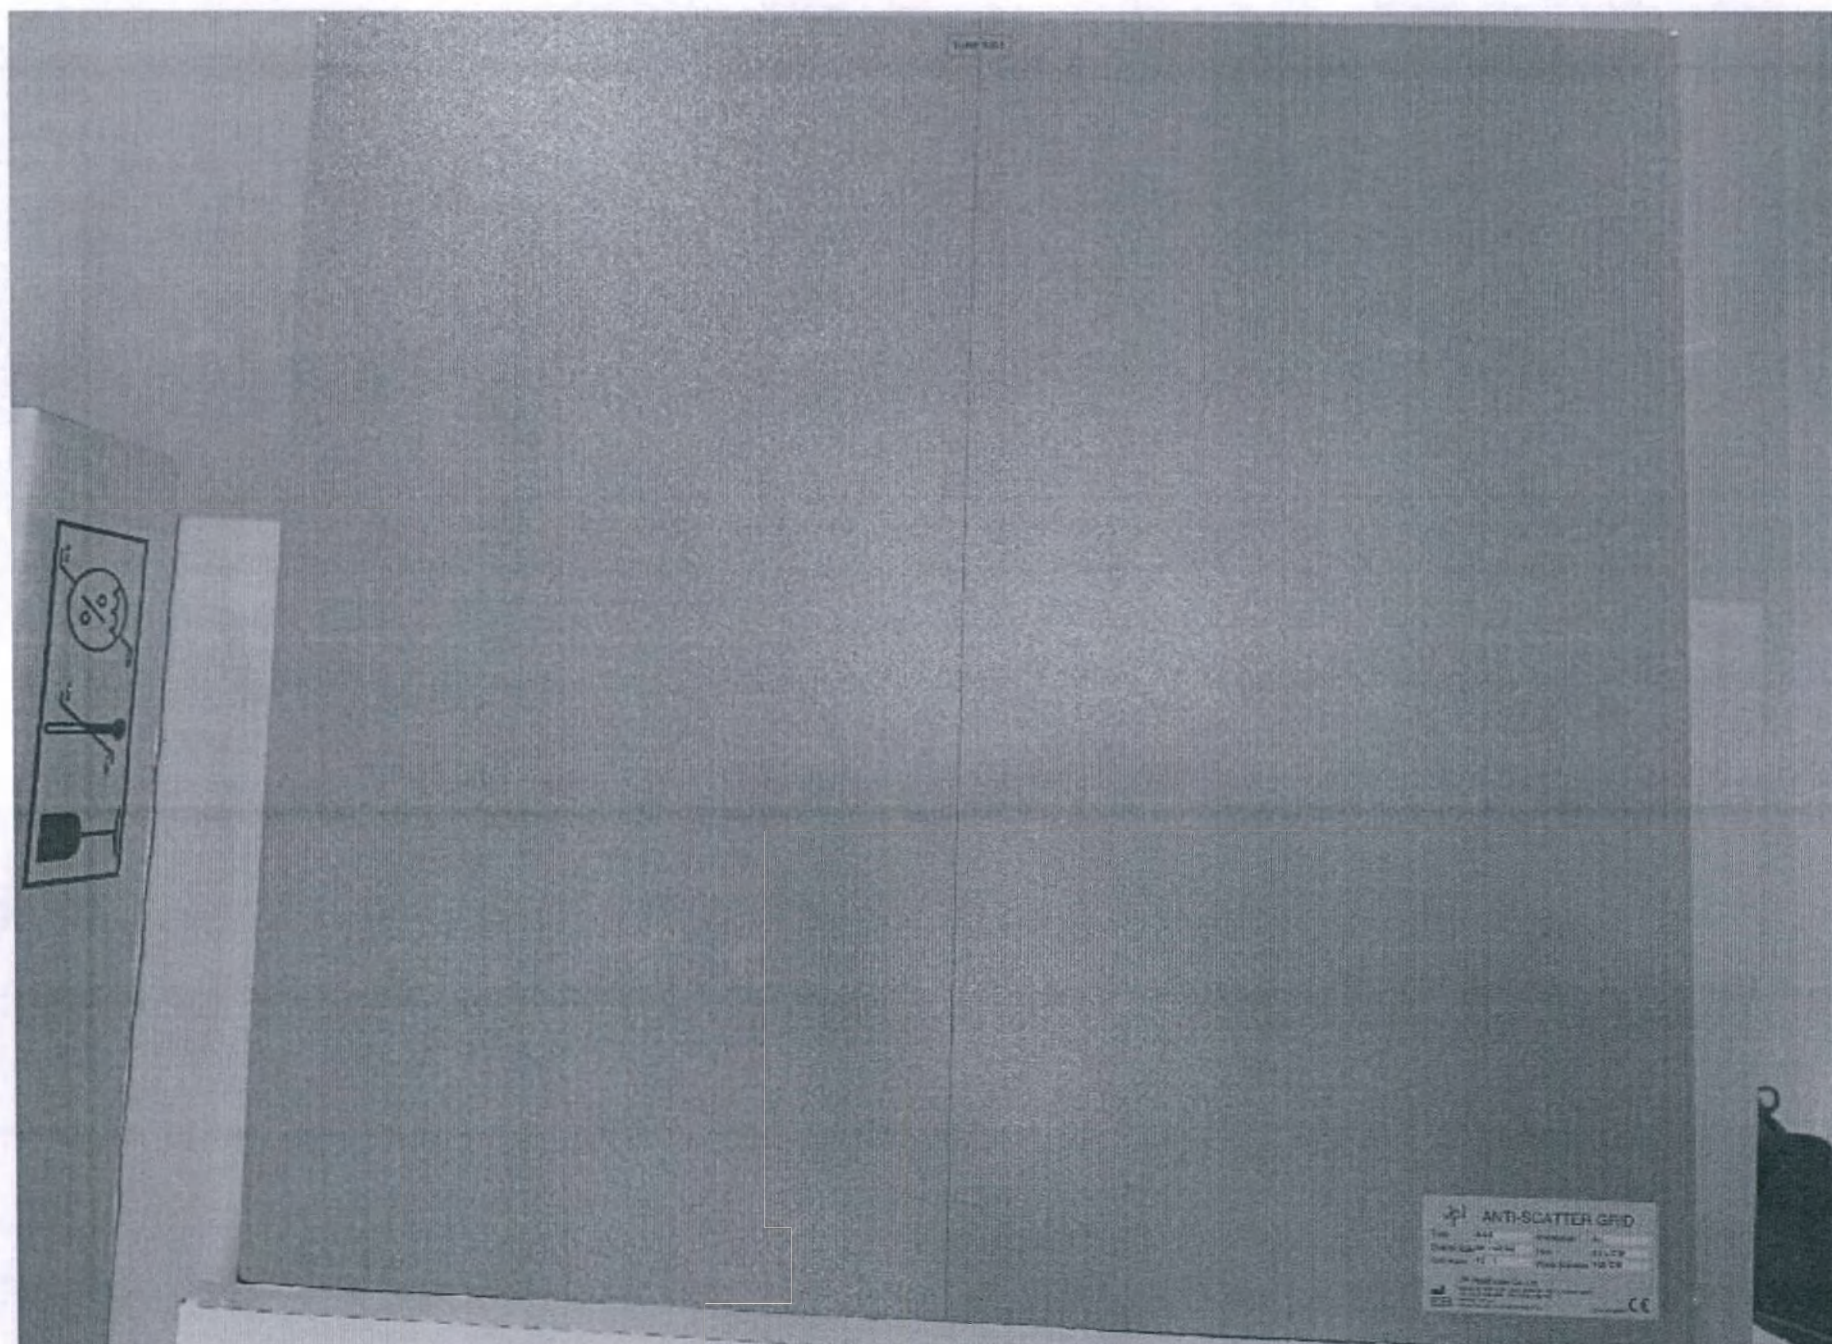


или производства Gilardoni S.p.A, Италия;

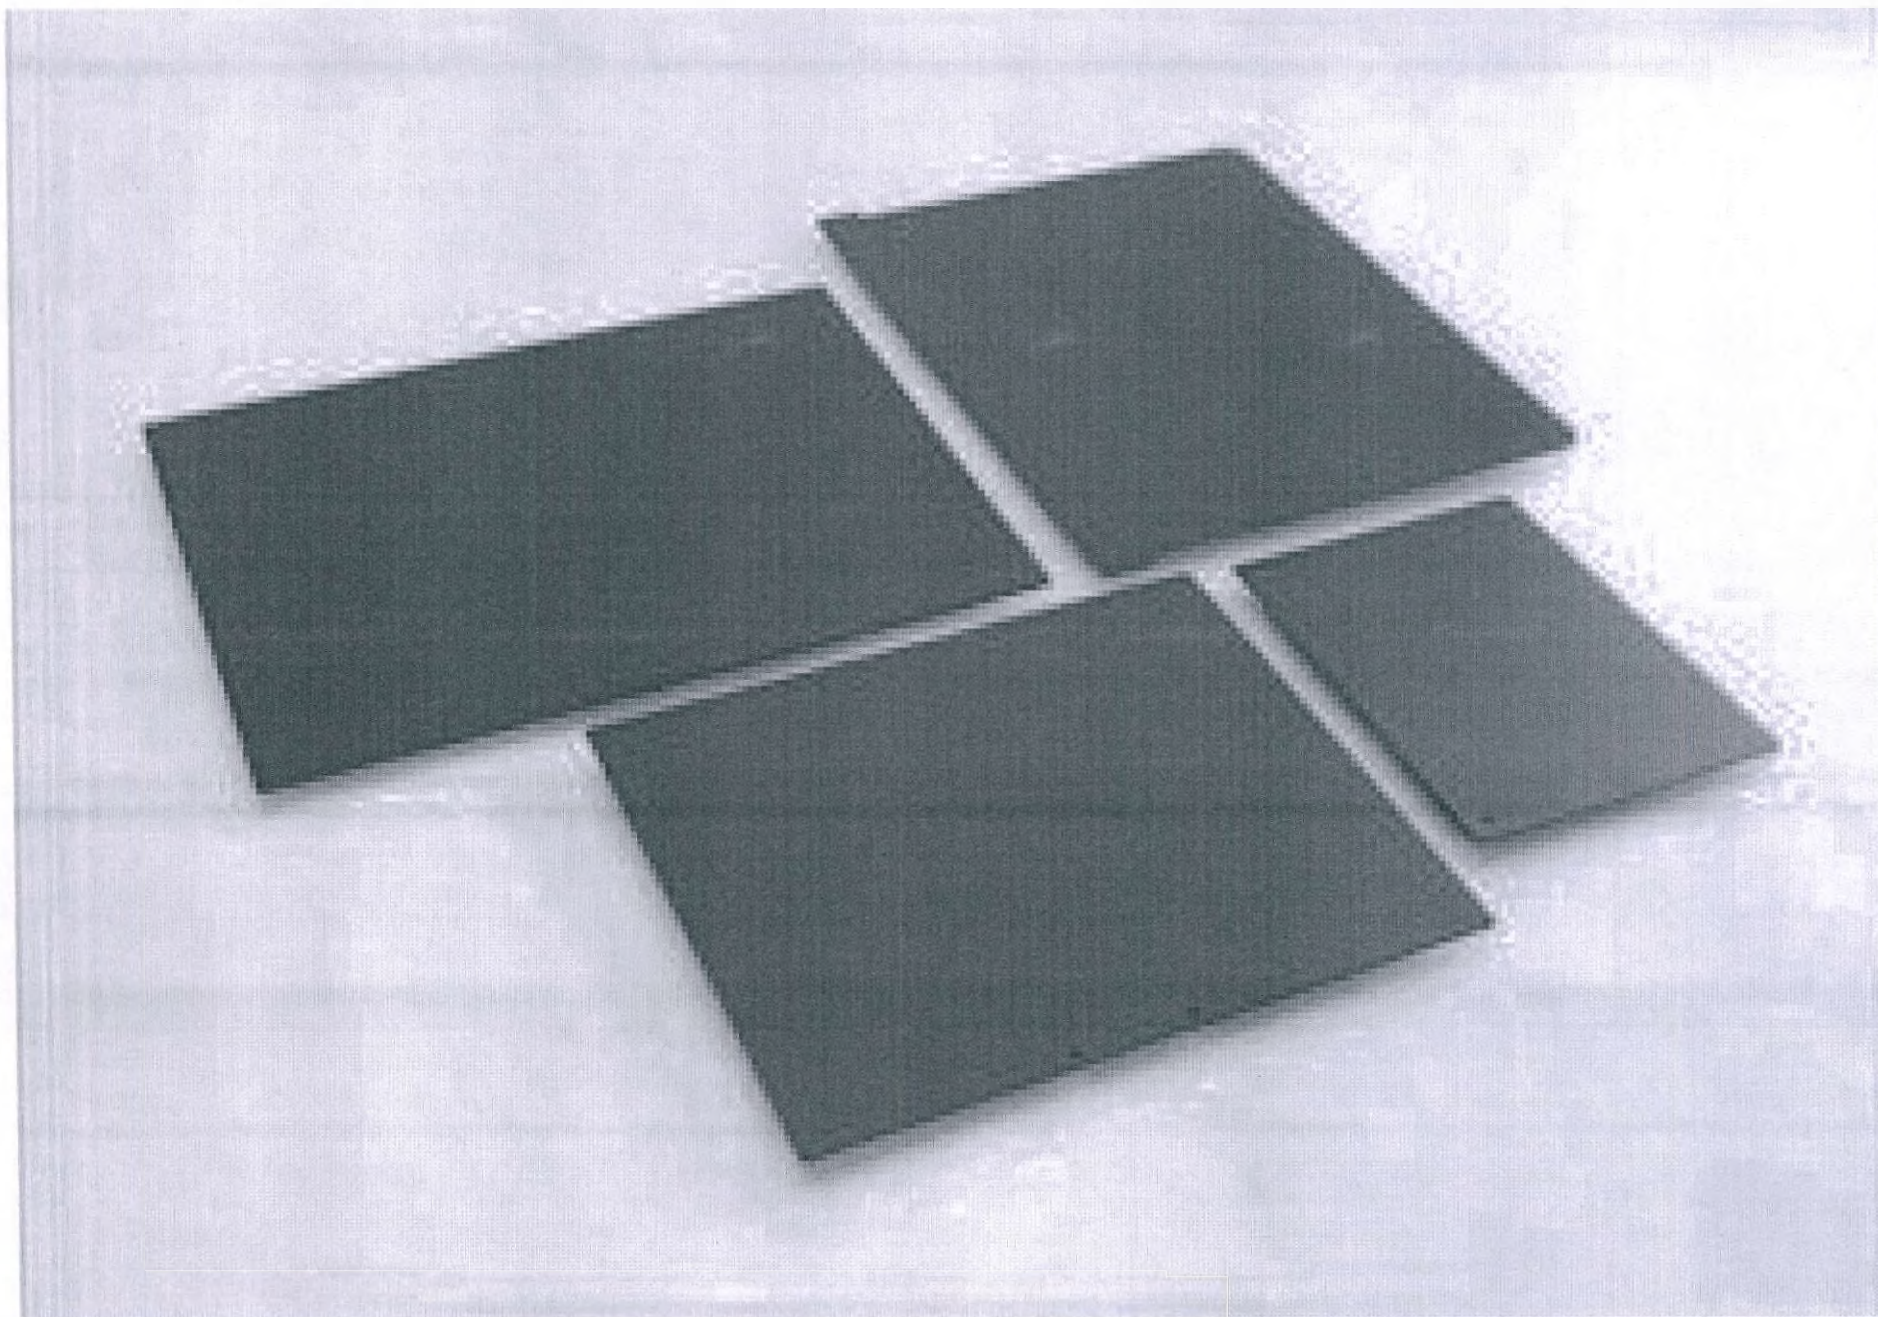


или Ysio производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

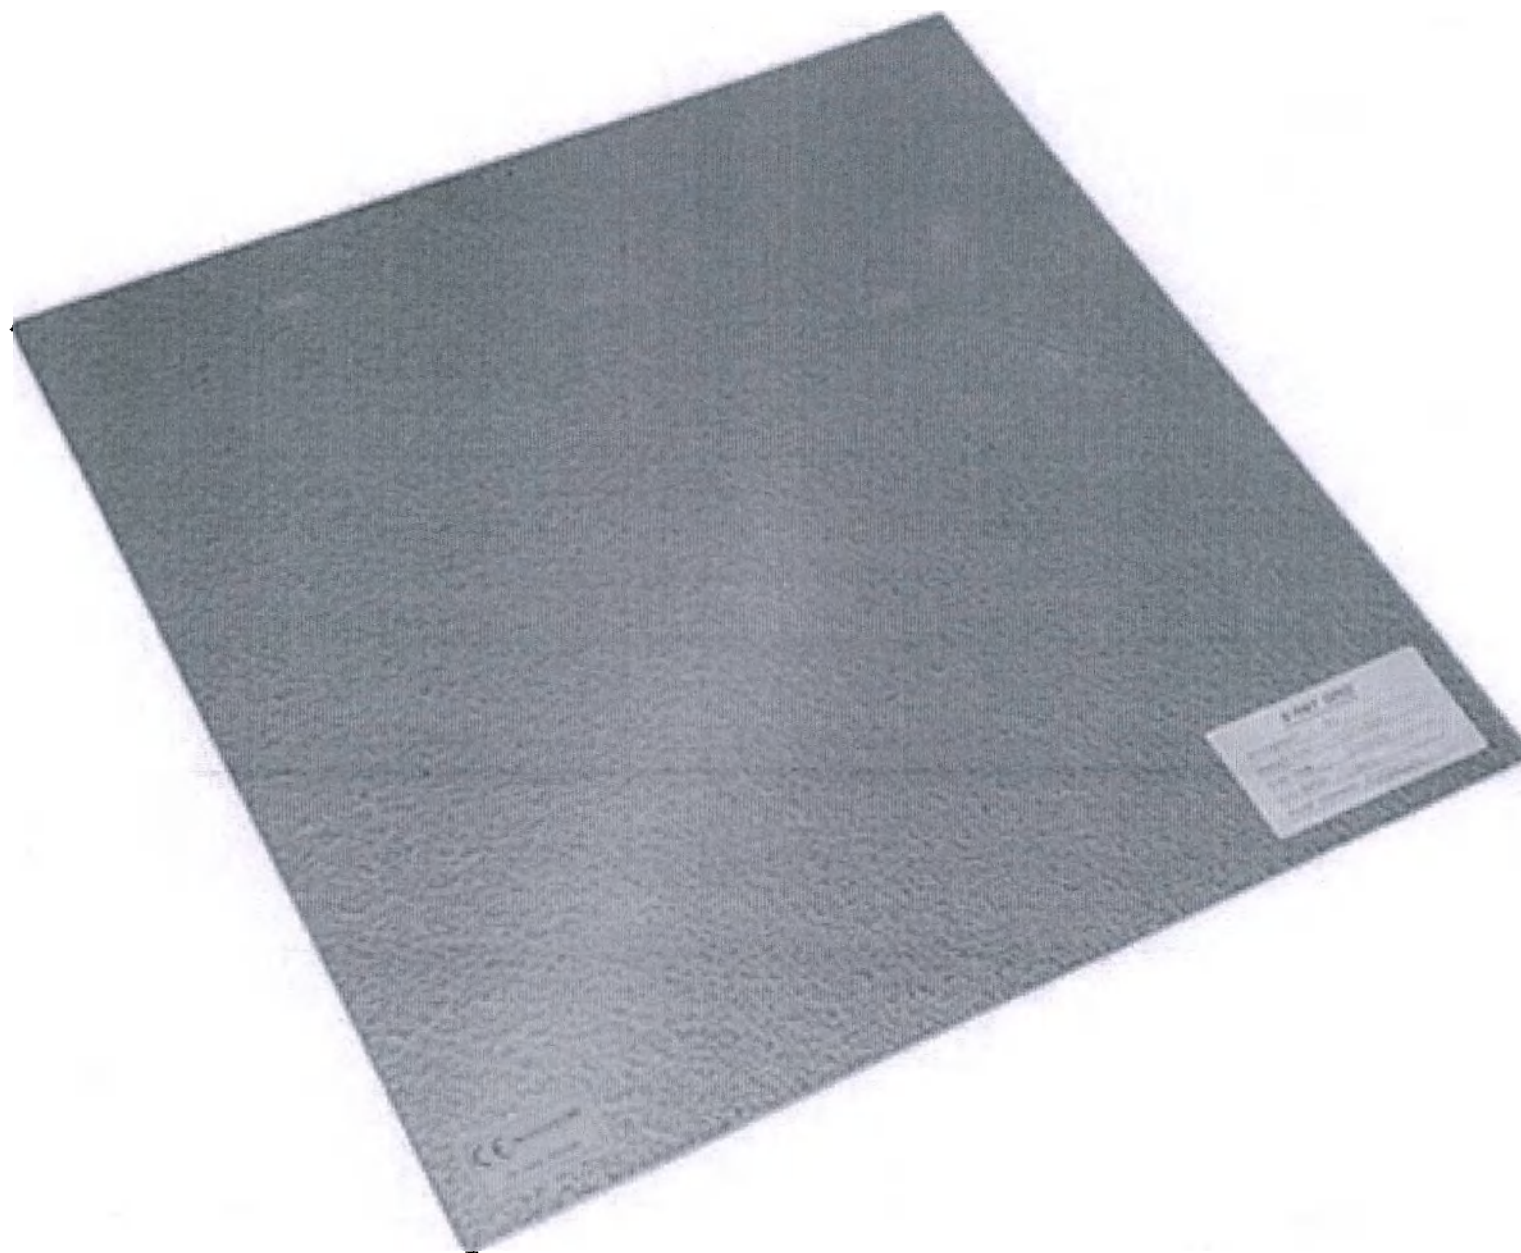


22. Камера ионизационная производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия;

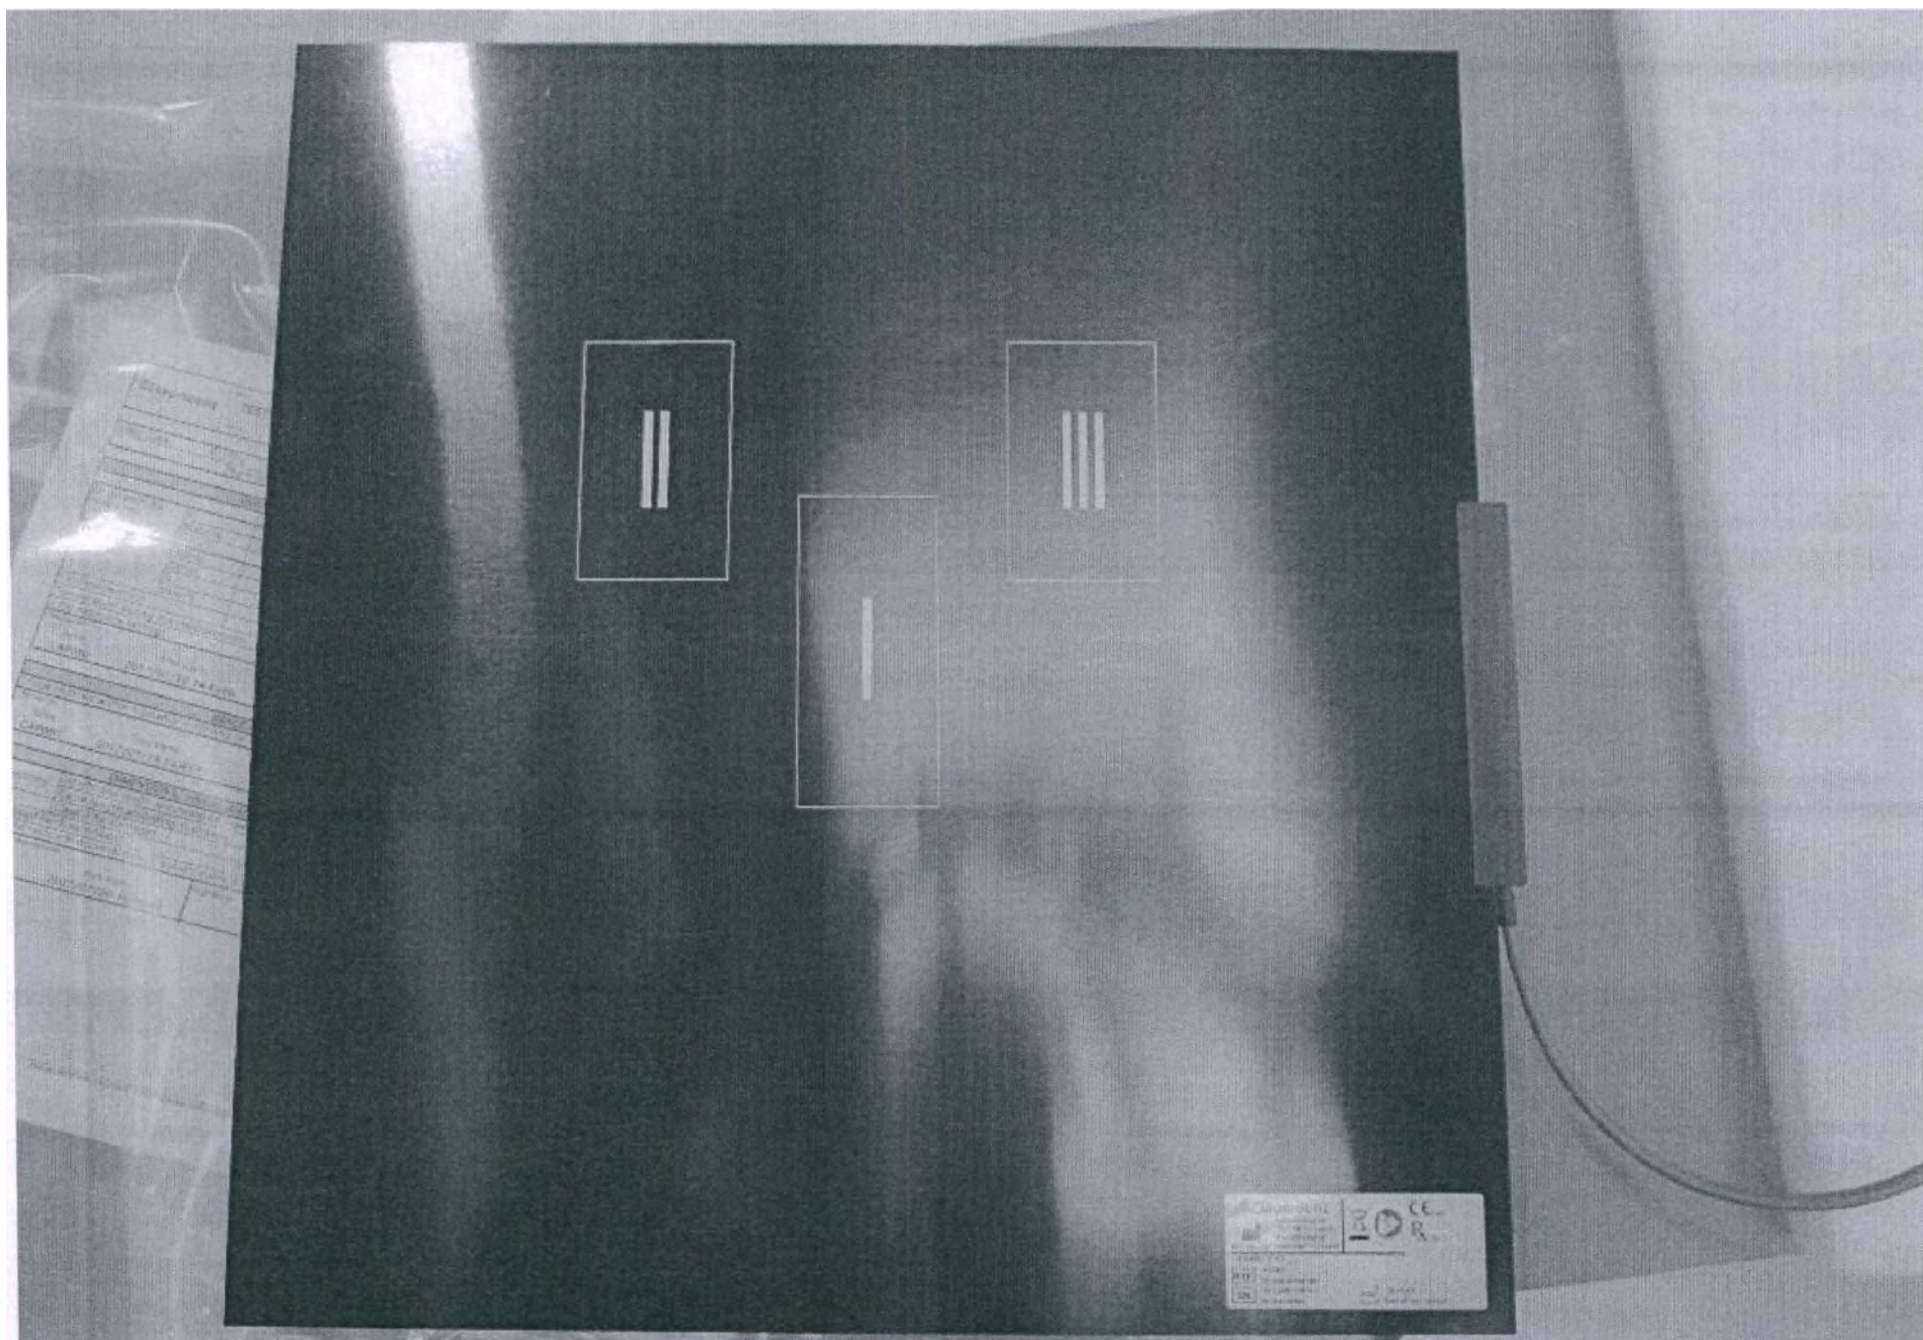


или SSMC; ICX В производства Varex Imaging Corporation, США;

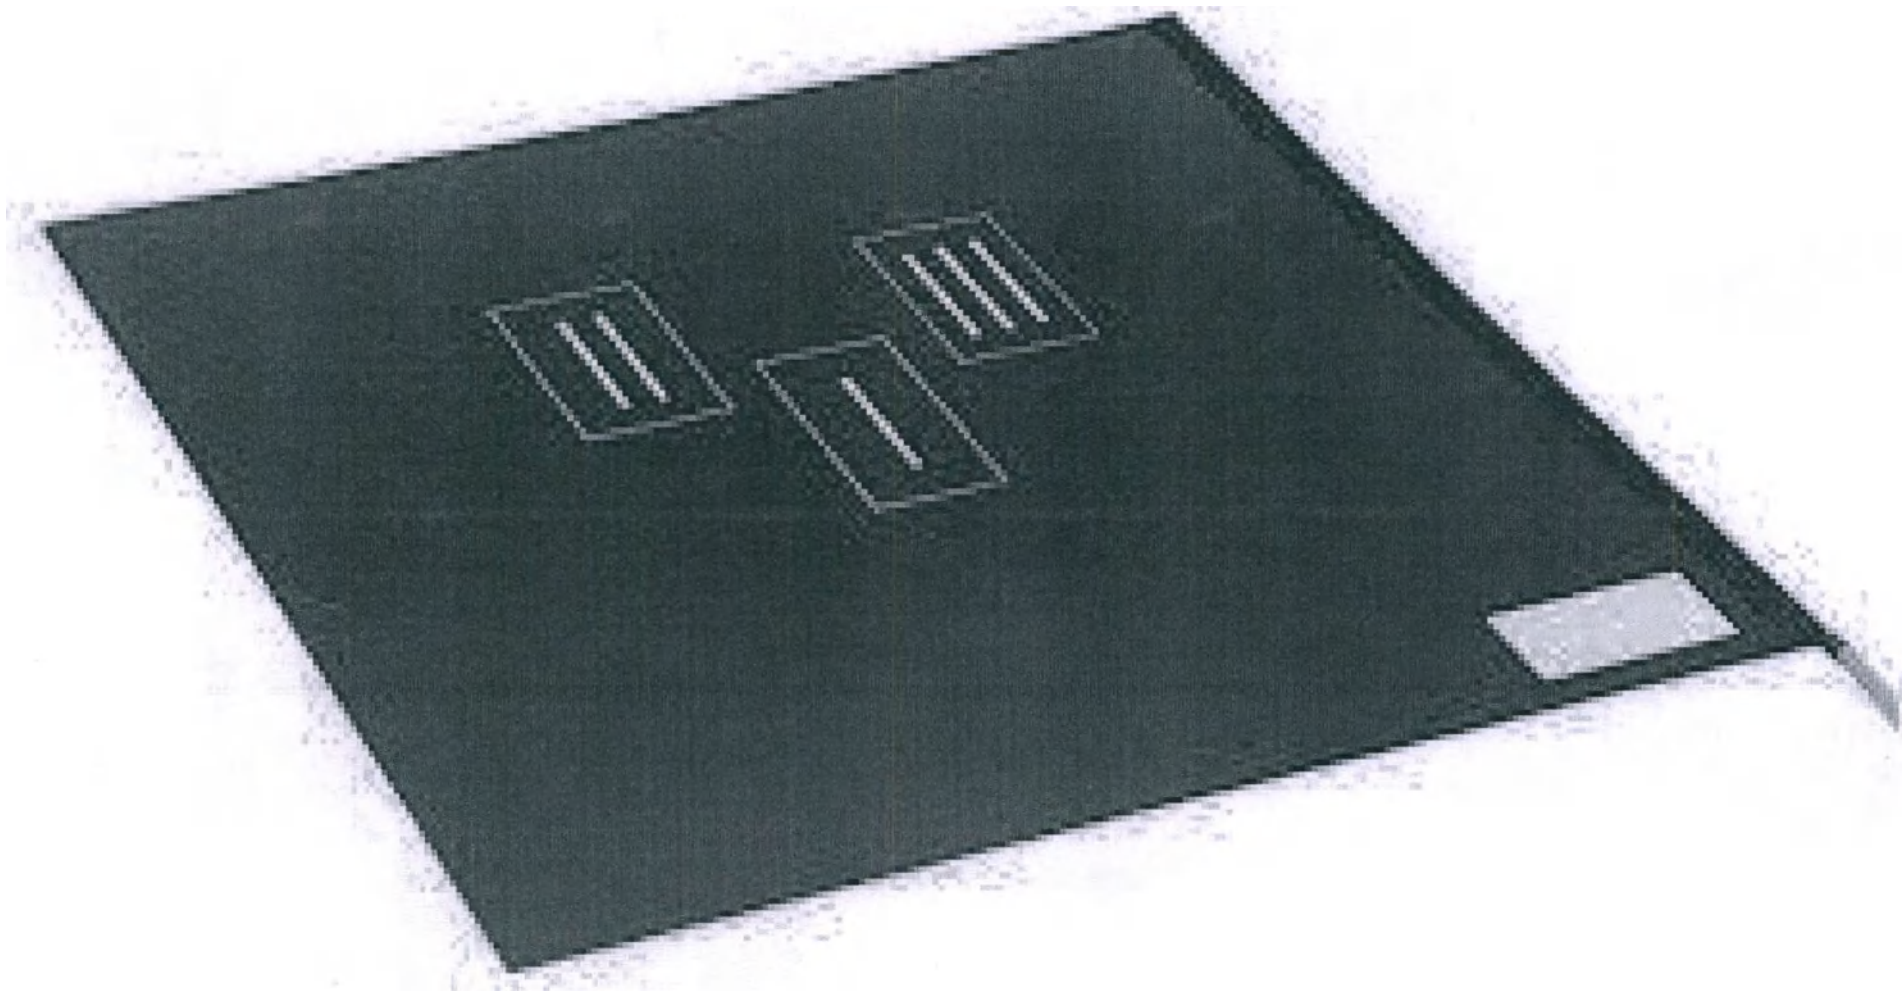

или XT; 5FA; 3FA производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

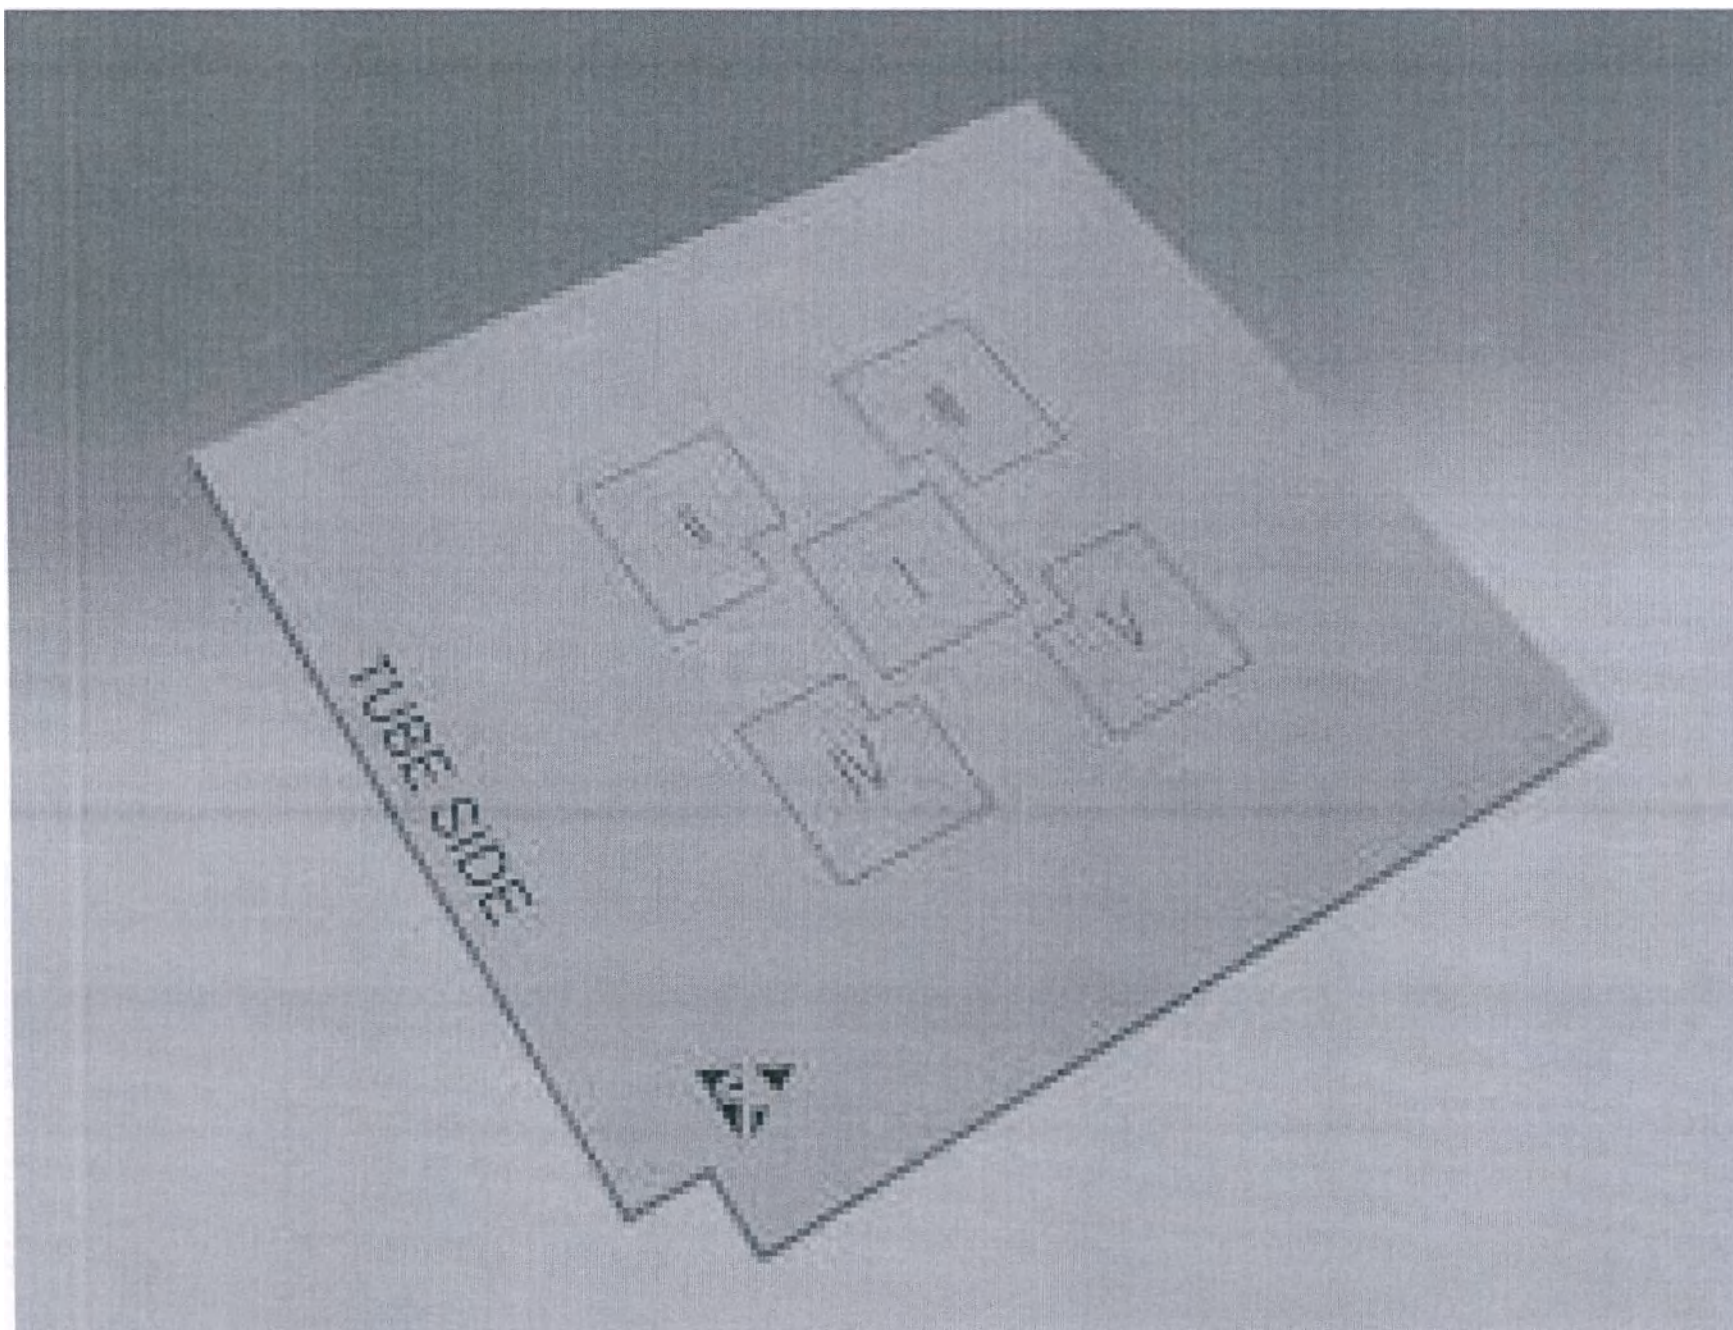


23. Программное обеспечение архива производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь; или программное обеспечение, специализированное «АПК АрхиМед» по ТУ 62.01.29-002-98944313-2015 производства ООО «МЕД-РЕЙ», Российская Федерация (РУ № РЗН 2019/8485); или комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 (РУ № РЗН 2017/5621) или комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по ТУ 9442-233-38226244-2015 (РЗН 2017/5616) производства ООО «ЛИНС», Российская Федерация.

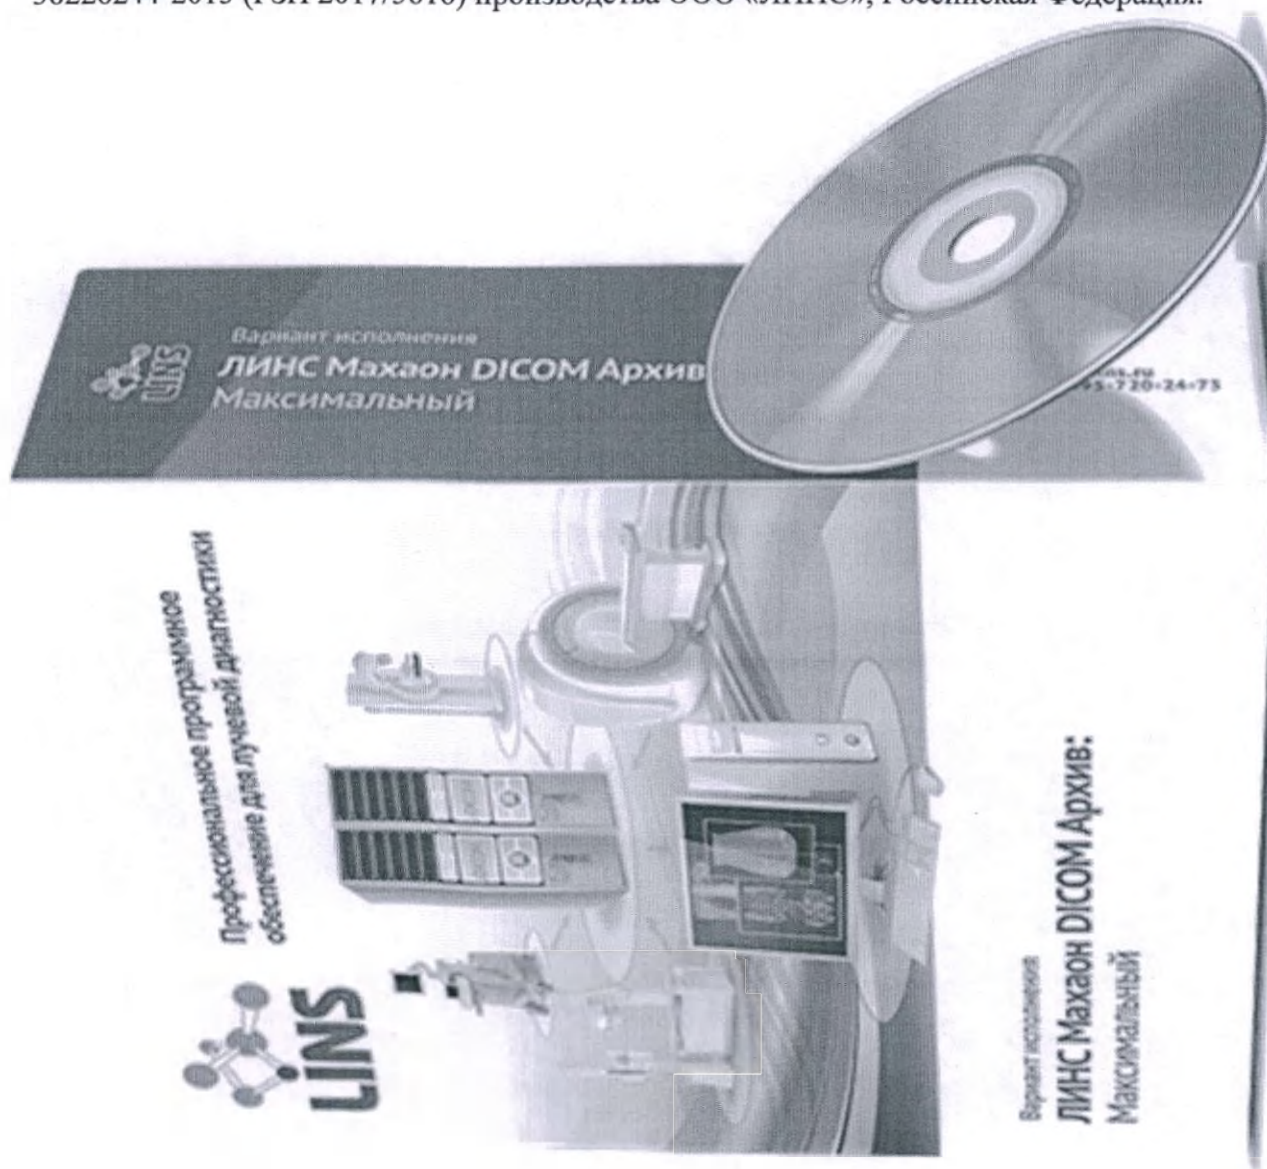


24. Автоматизированное рабочее место (АРМ) производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.



25. Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002 производства ЗАО «ПОНИ», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/11811);

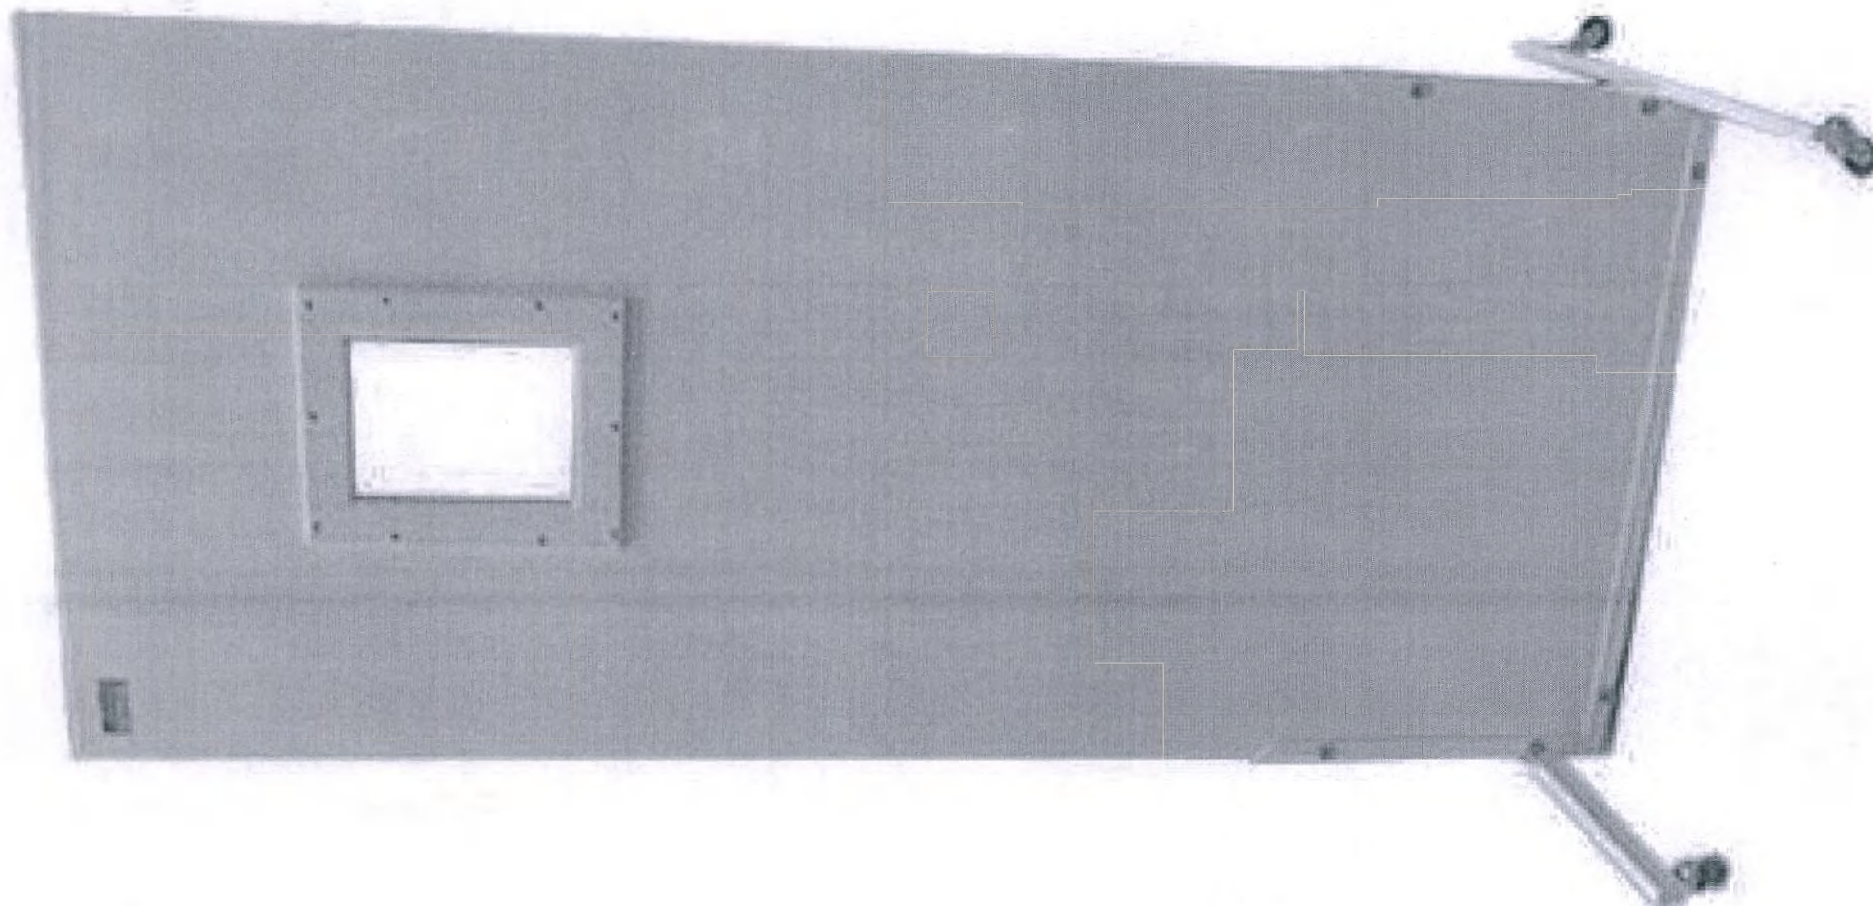


или ширмы рентгенозащитные резиносвинцовые передвижные по ТУ 9452-010-46782692-2001 производства «Рентген-Комплект», Российская Федерация (ПУ № ФСР 2011/10476).

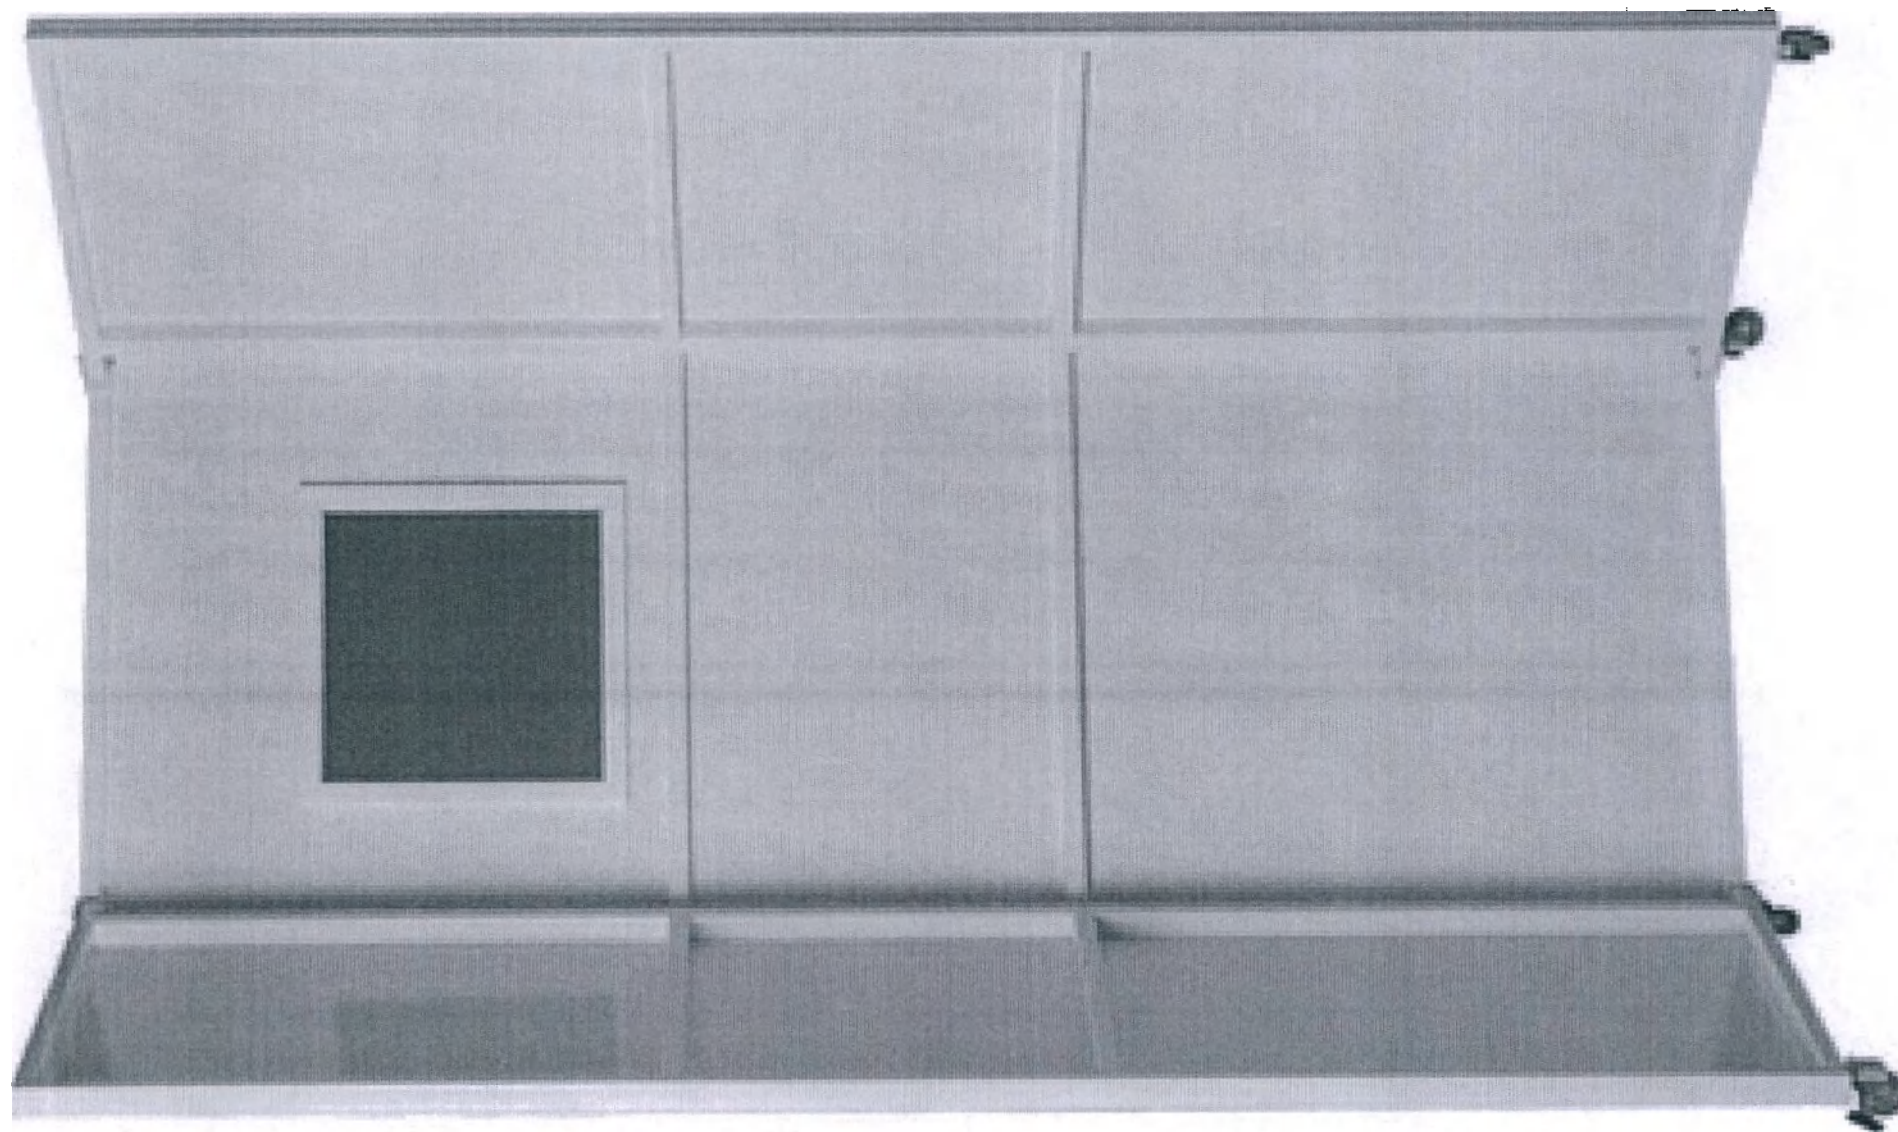


26. Стол для пациента мобильный производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори».




27. Люлька детская двойного поворота передвижная для полипозиционных исследований ЛДДП-1 по ТУ 9442-027-11396834-2006 производства ООО «СпектрАп», Российская Федерация (РУ № ФСР 2010/09430).

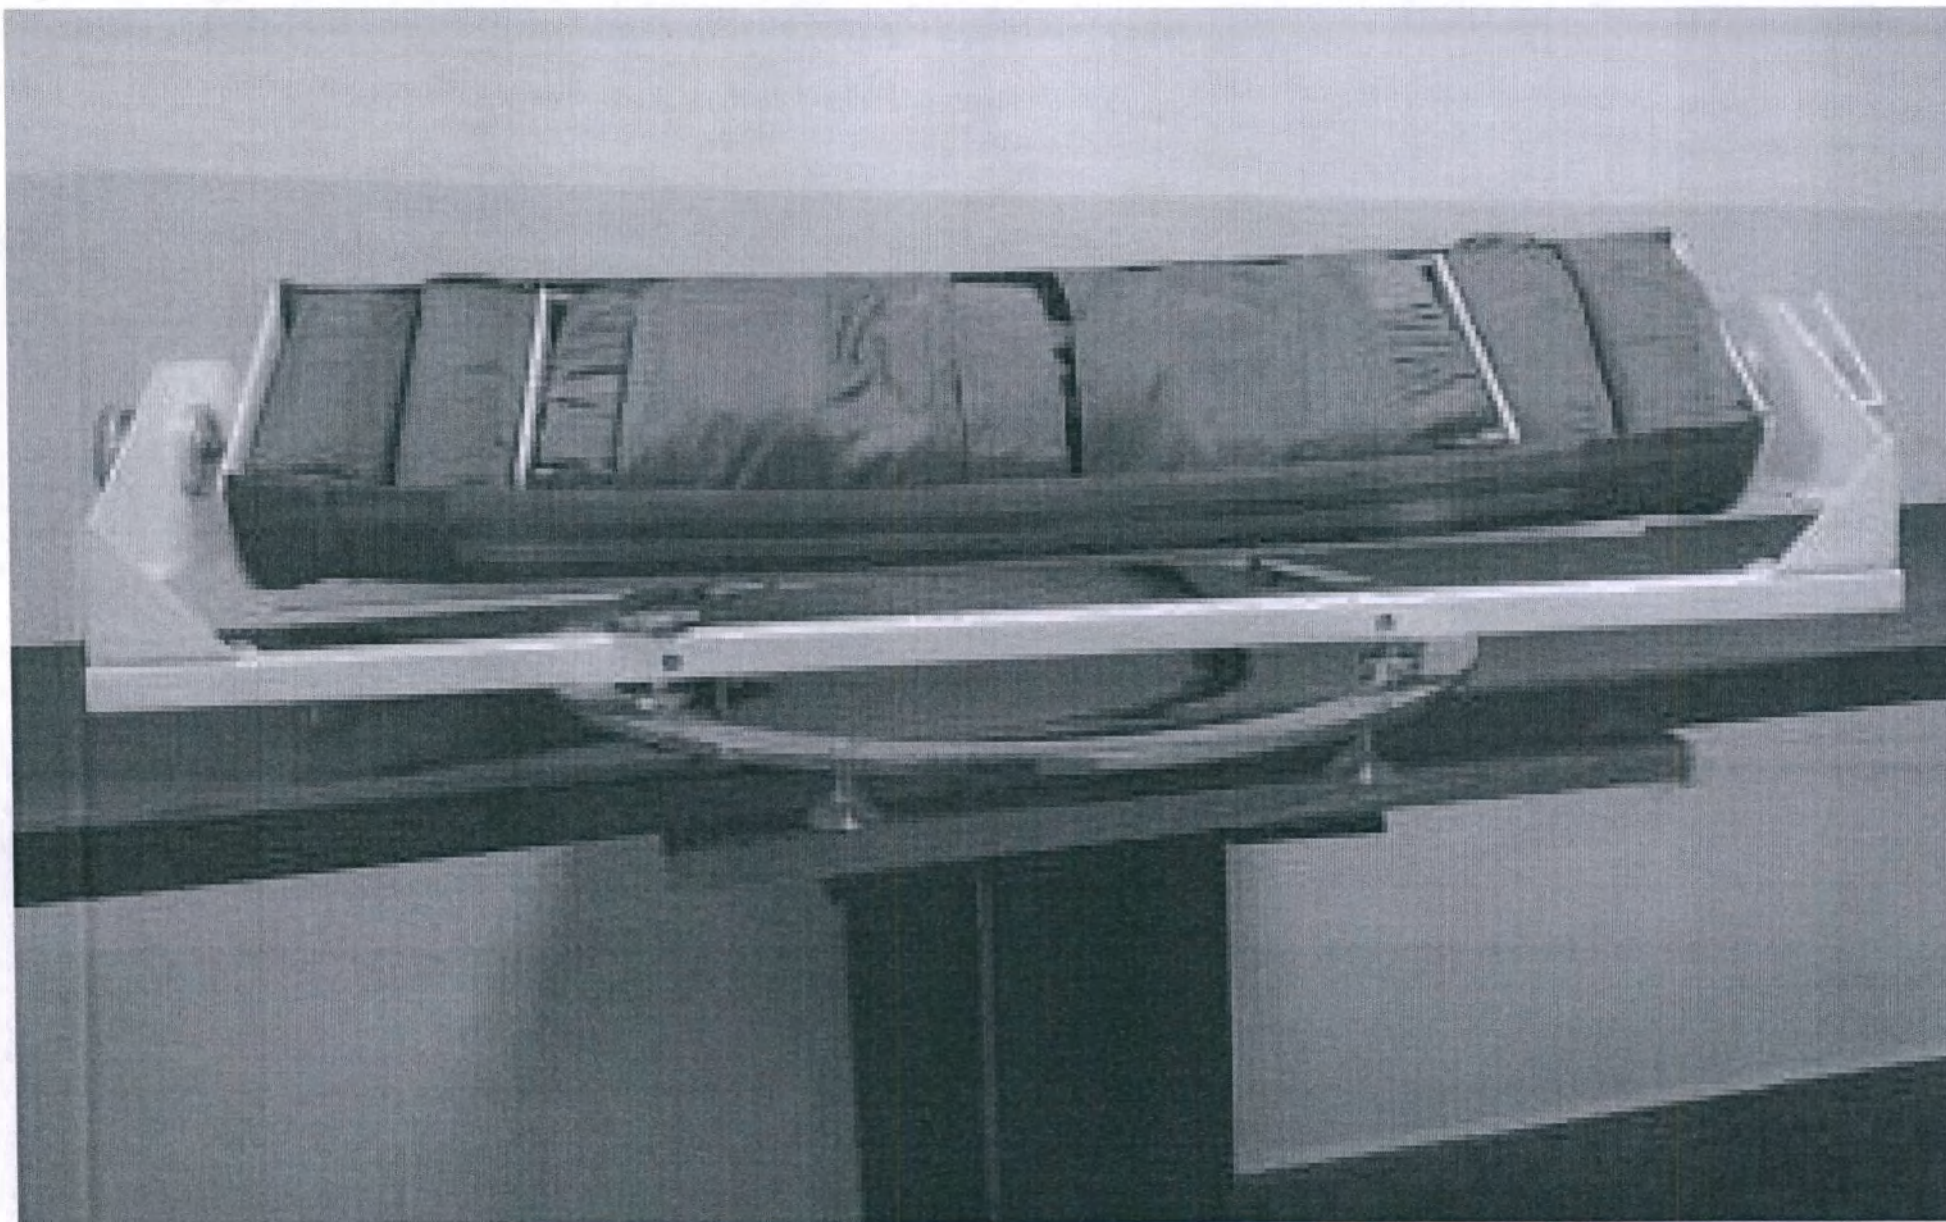

28. Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-800020198-2010 производства ИП Давлетов Д.Я., Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/09994);

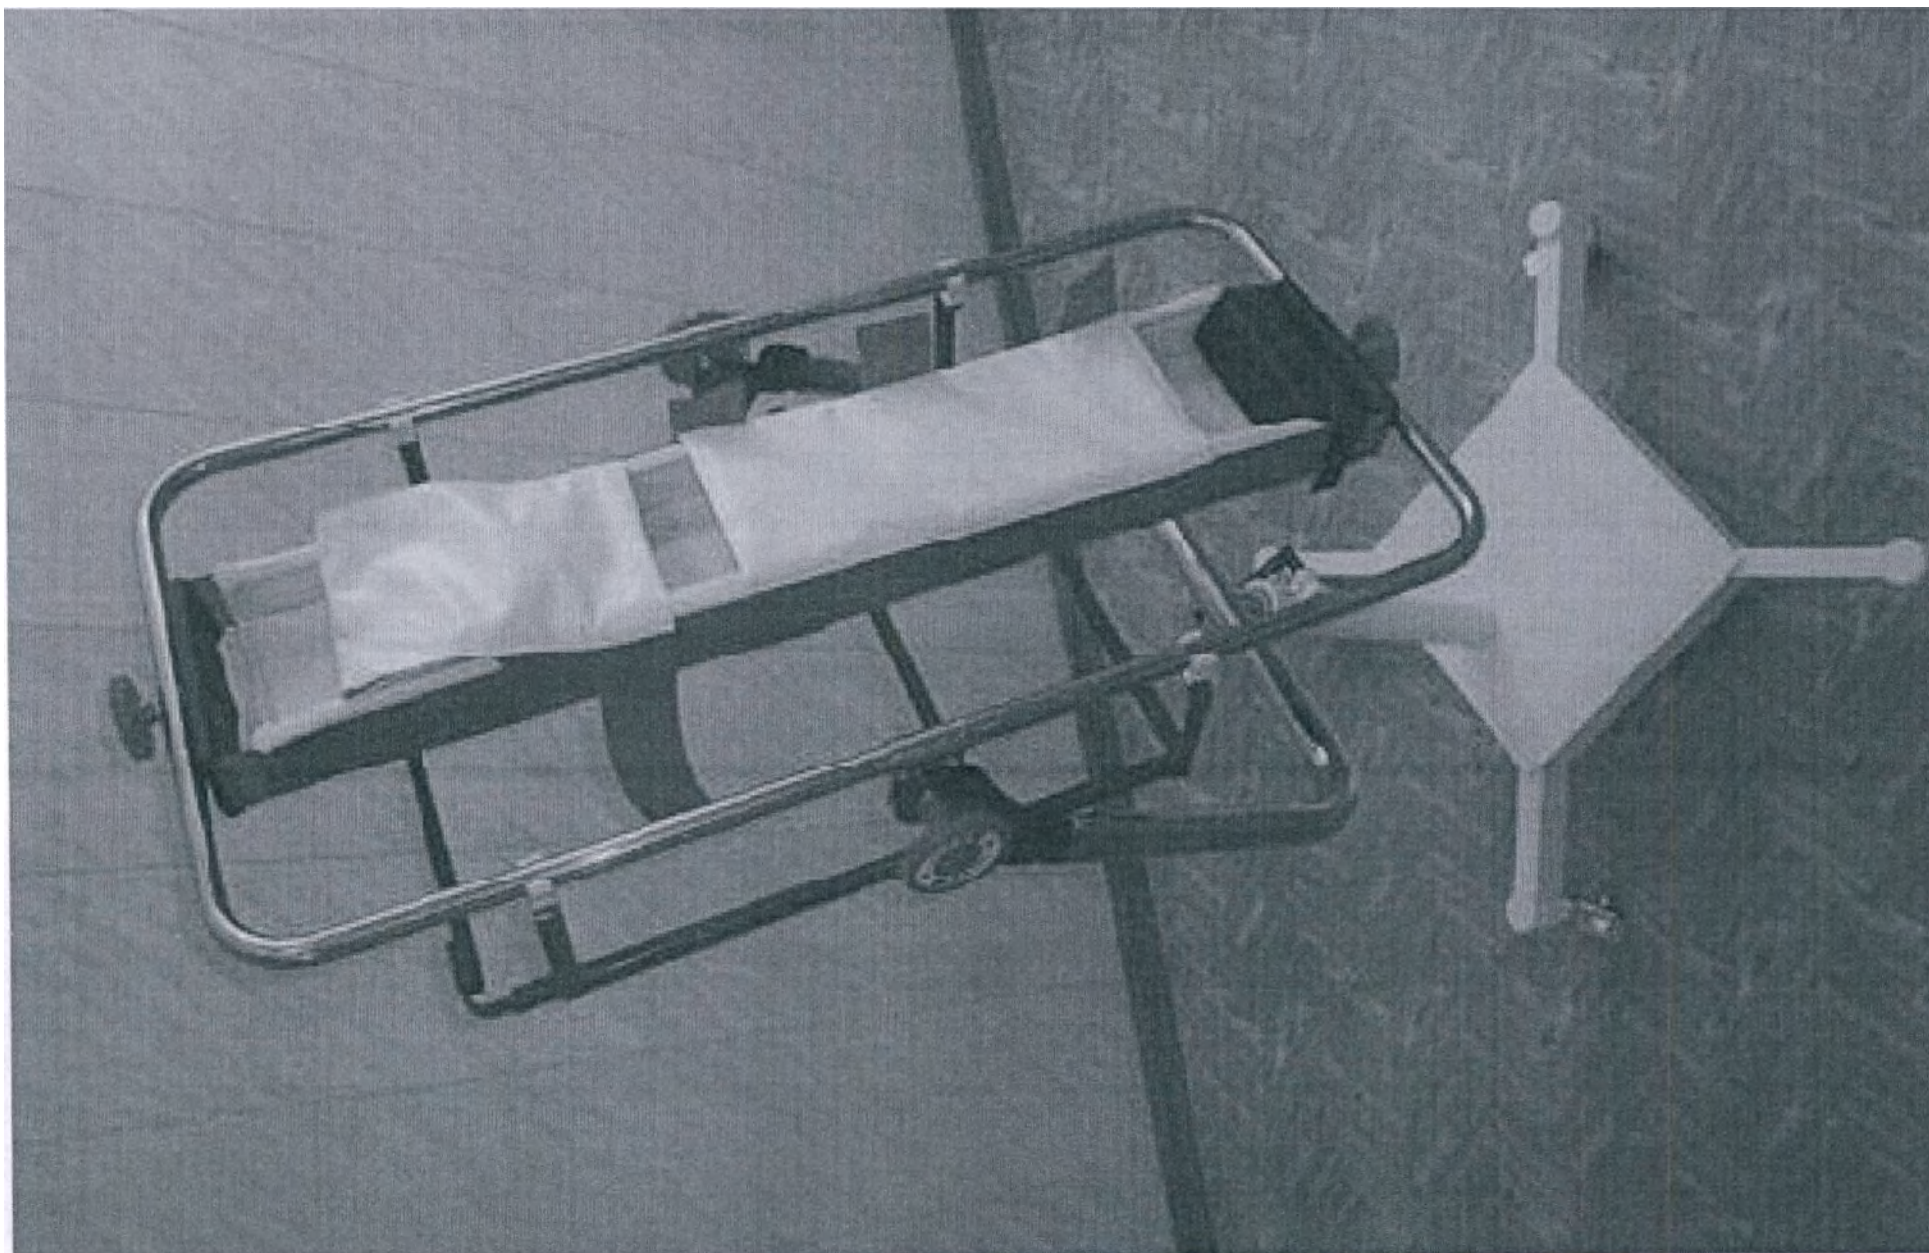

или устройство для позиционирования детей Octopaque или Minipaque или Octoroll производства фирмы Oktostop inc. Канада;

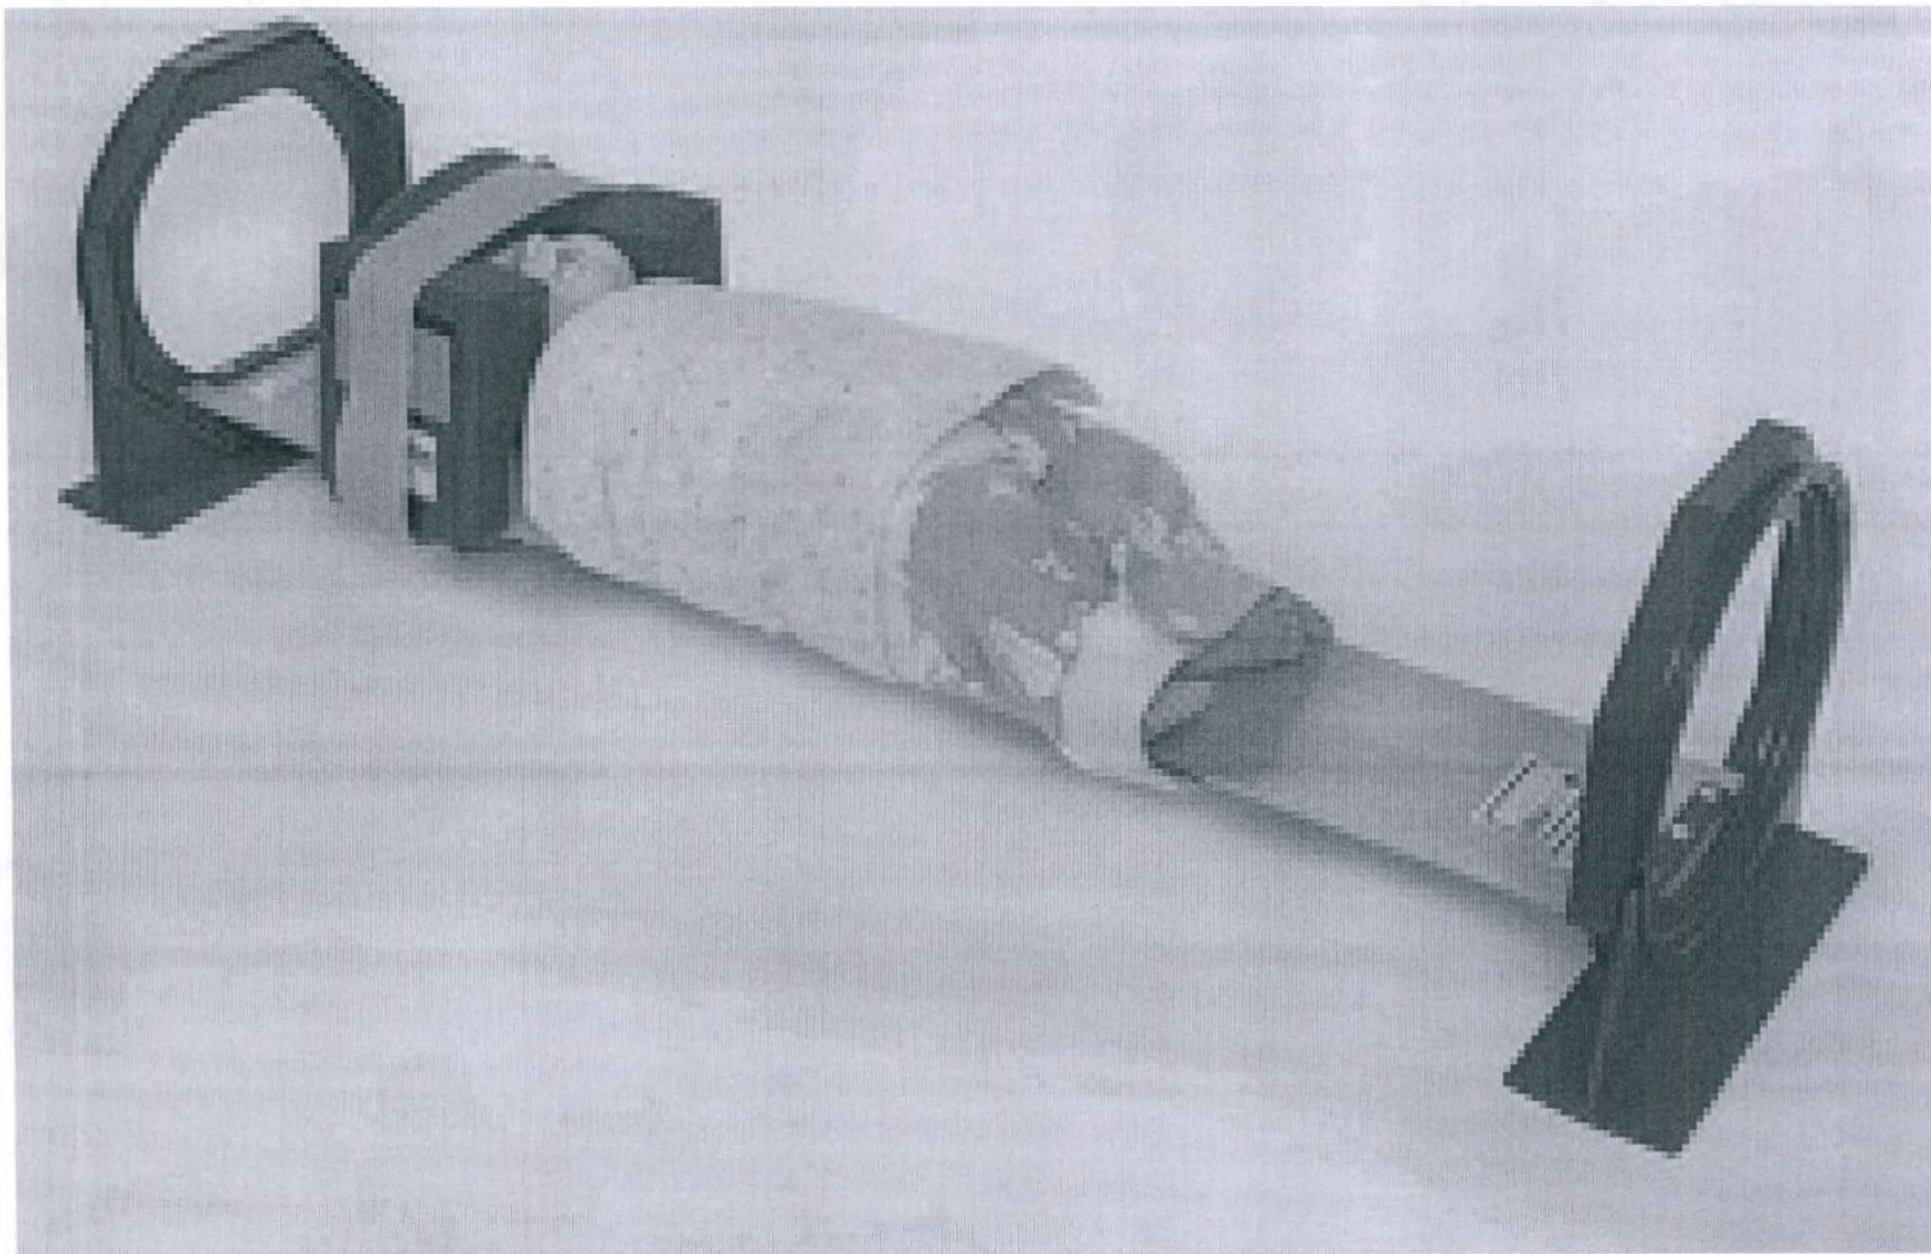


или «РЕНЕКС УРИД» производства фирмы ЗАО "РЕНЕКС", Российская Федерация; или производства ООО «С.П. Гелпик», Российская Федерация.




29. Машина для проявления медицинских рентгеновских пленок SRX-101A производства Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., Япония (РУ № РЗН 2013/1252).




II. Состав «УНИЭКСПЕРТ 2 плюс»:

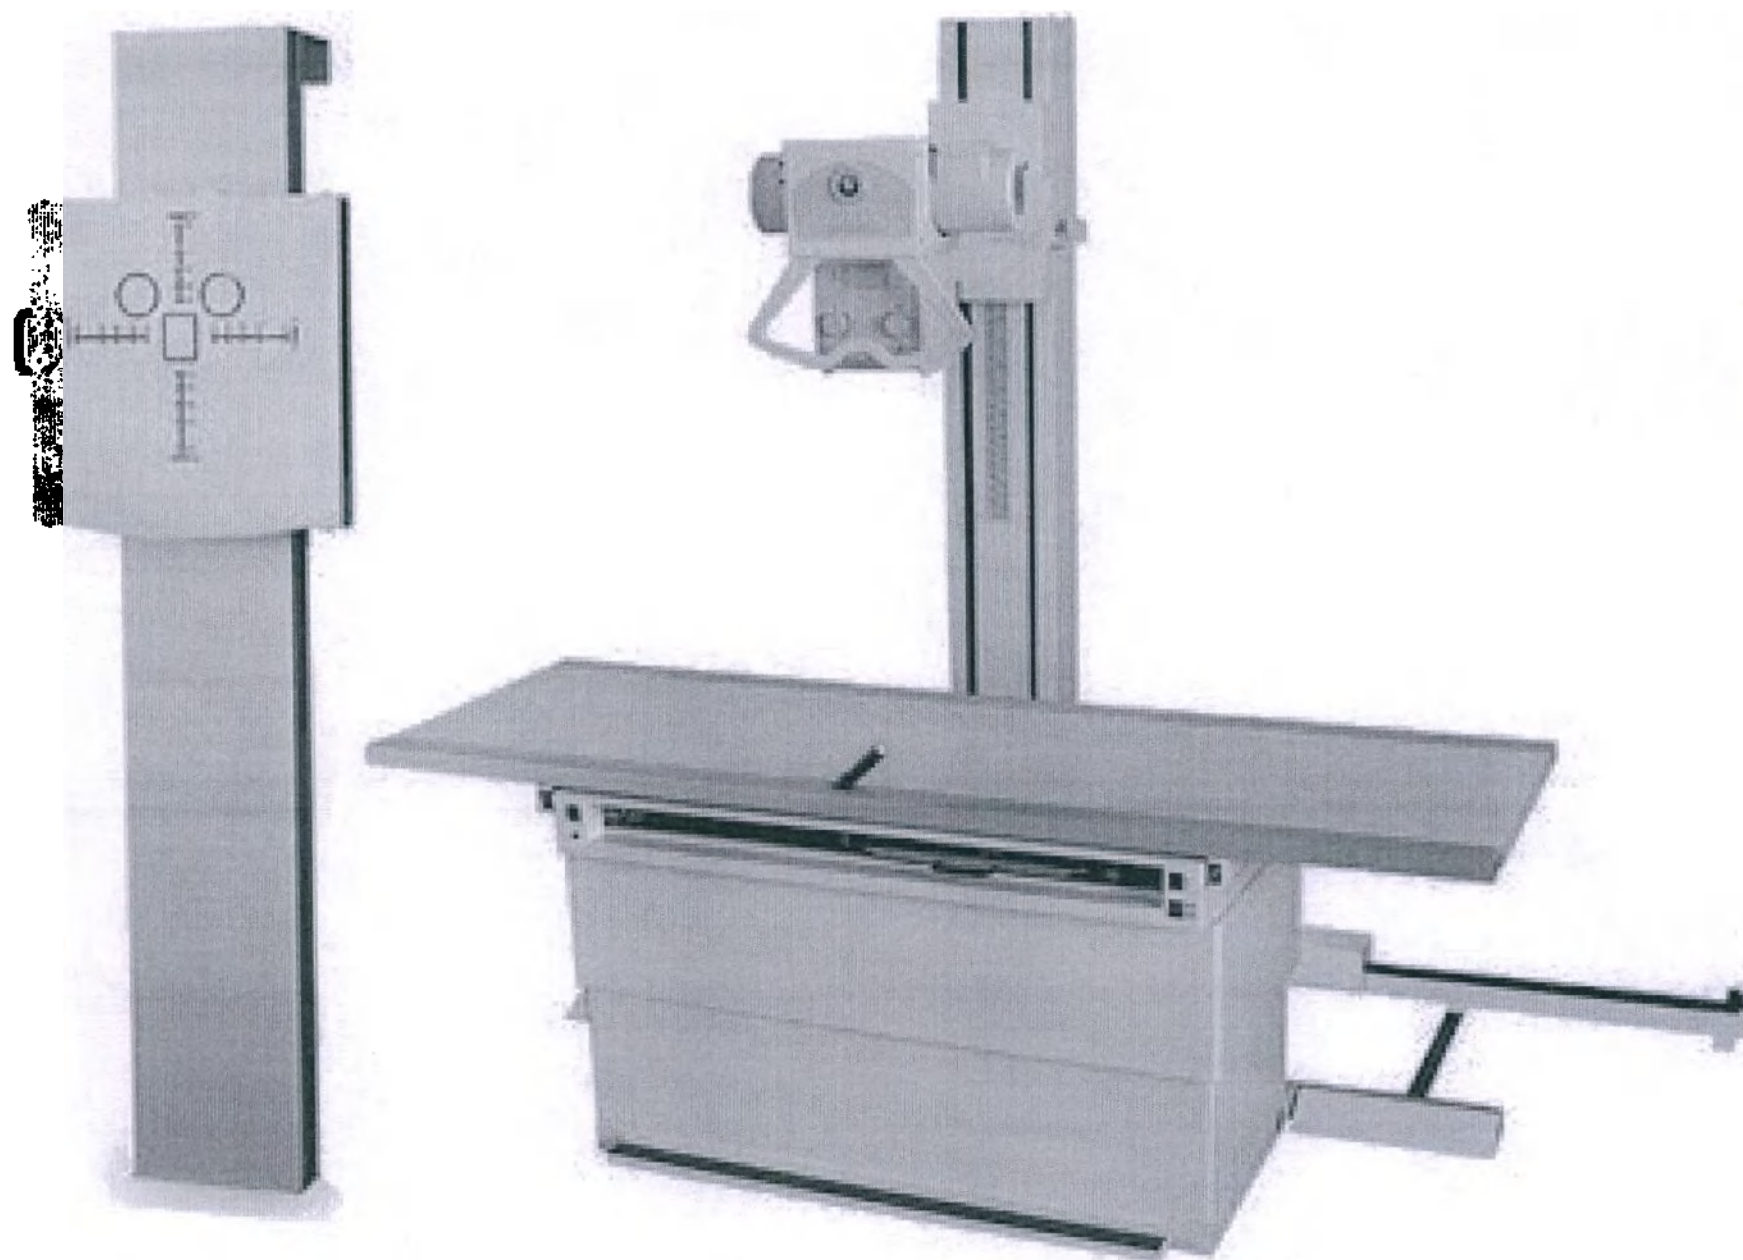


1. Стол рентгенографический IMX производства Imago Radiology S.r.l., Италия;

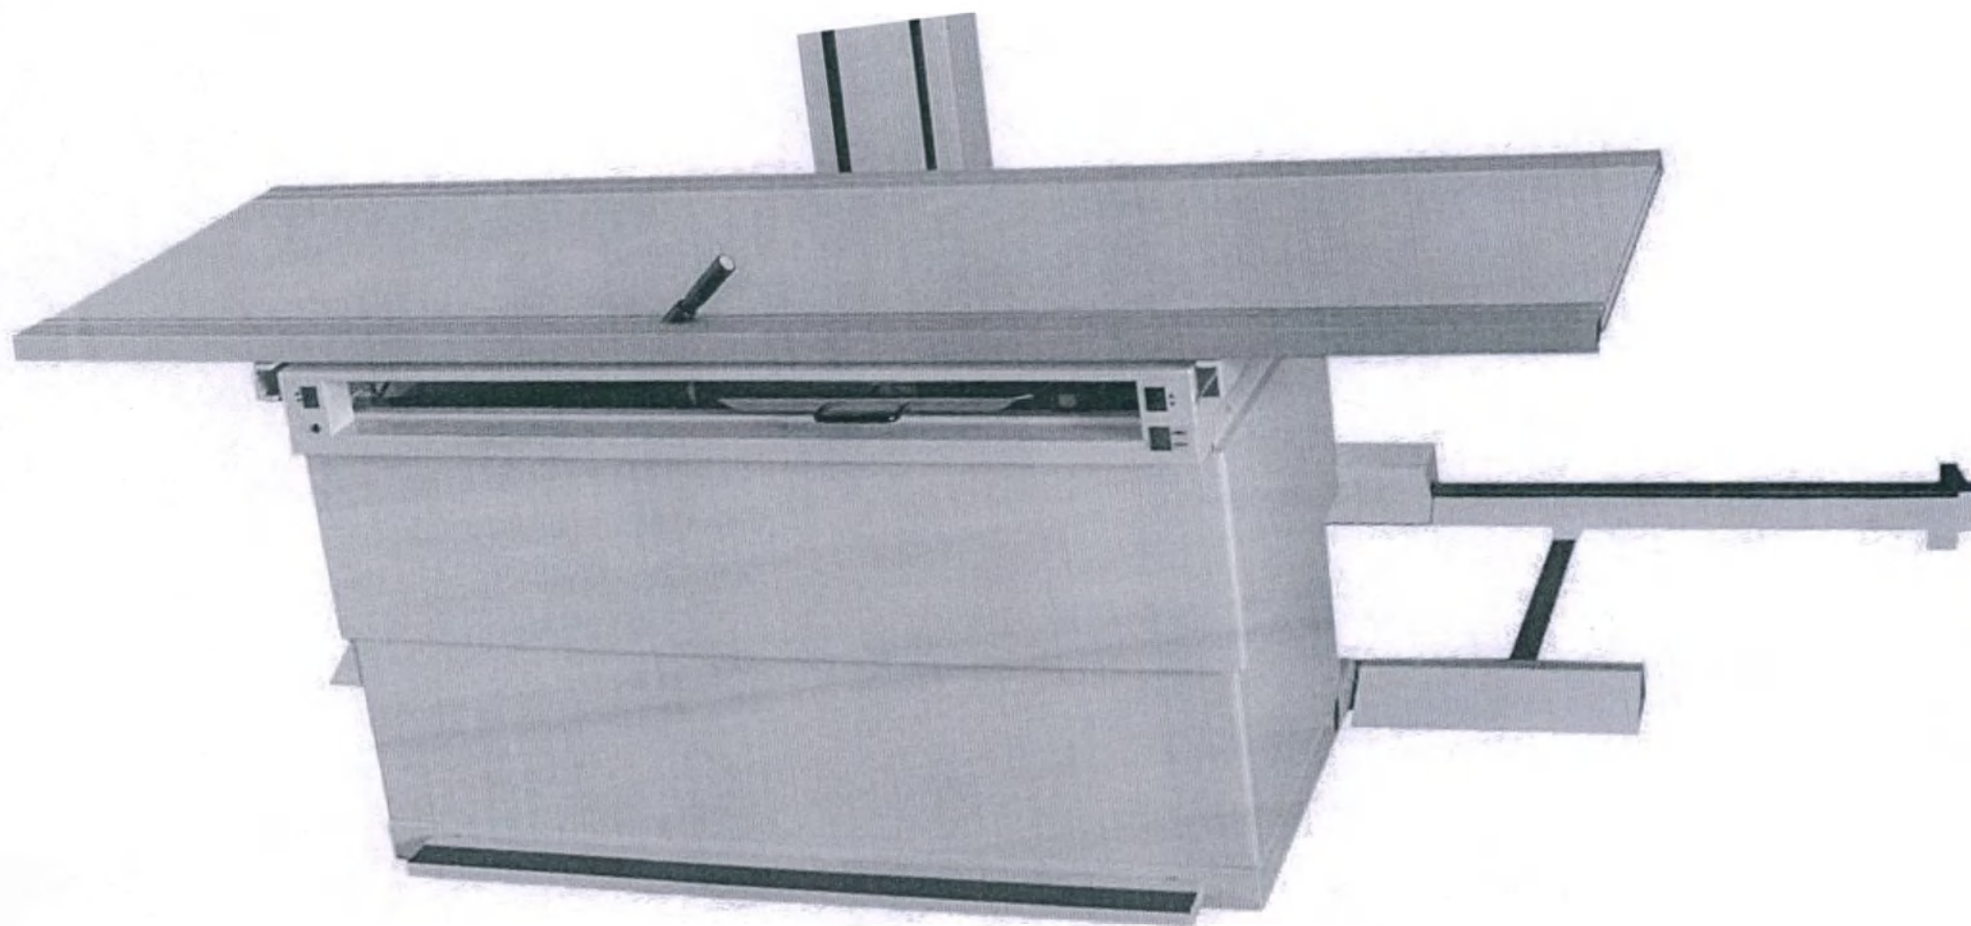


или Millenium производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания;

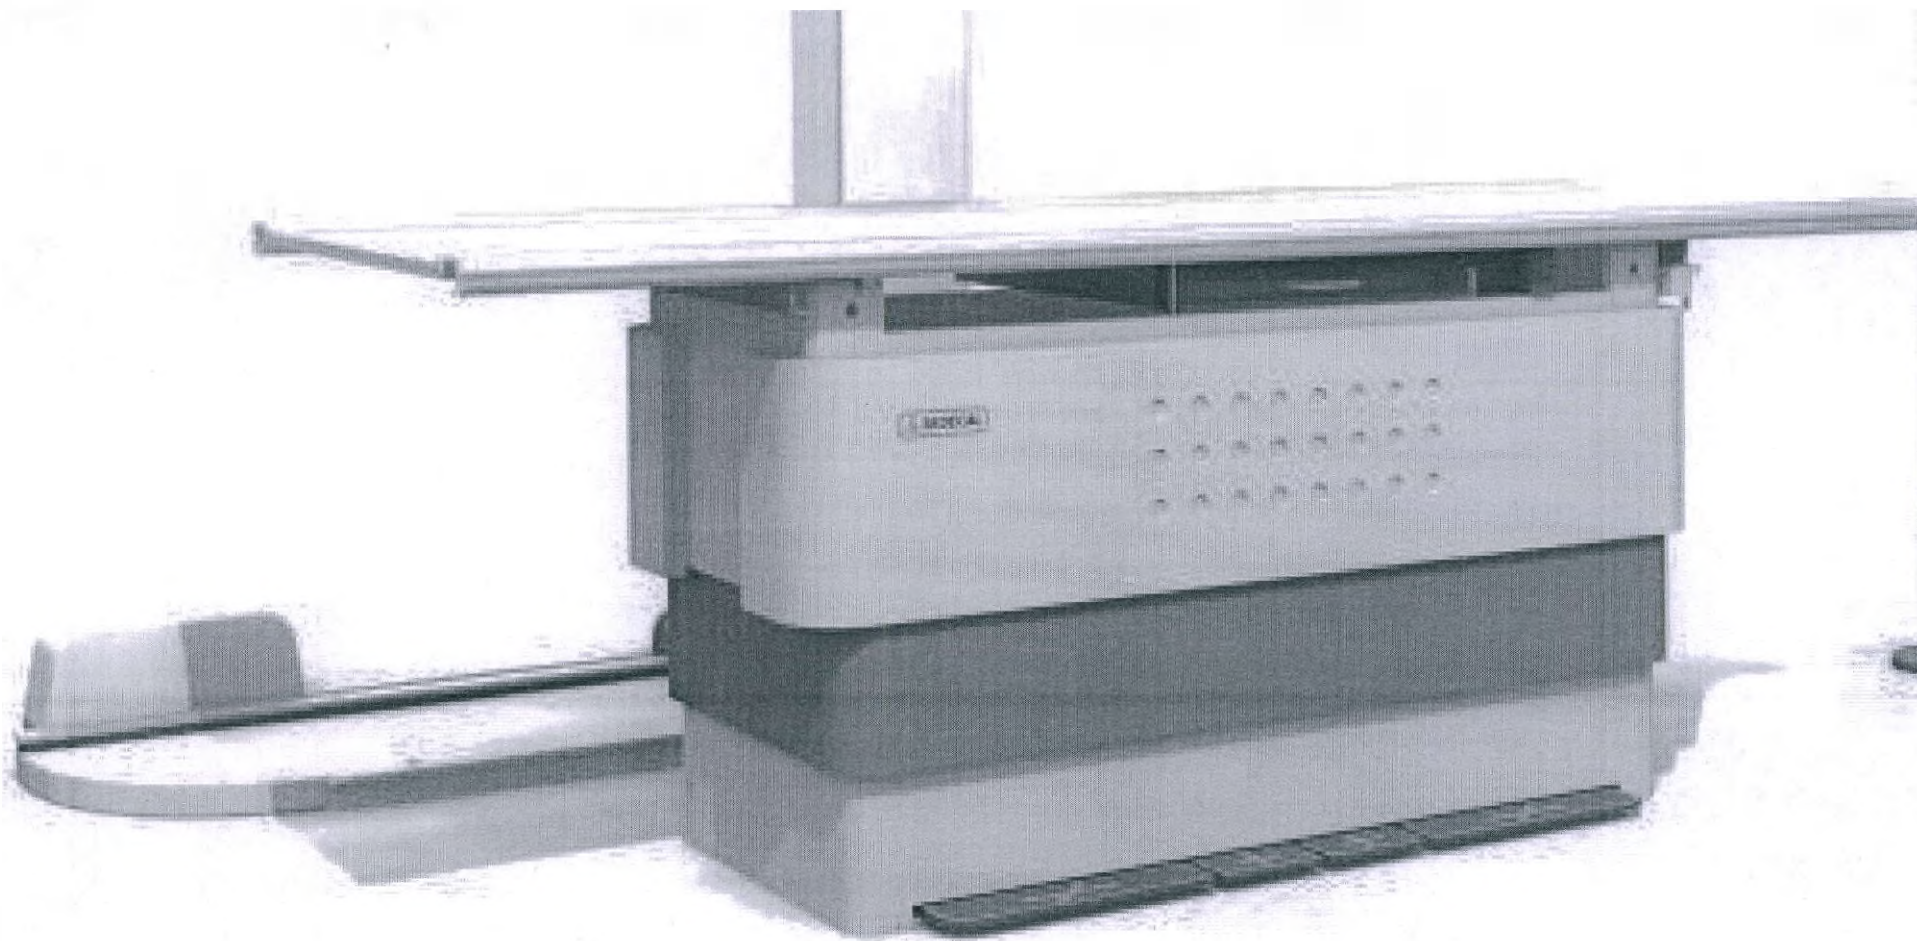


или МТО производства General Medical Merate SPA (GMM), Италия;

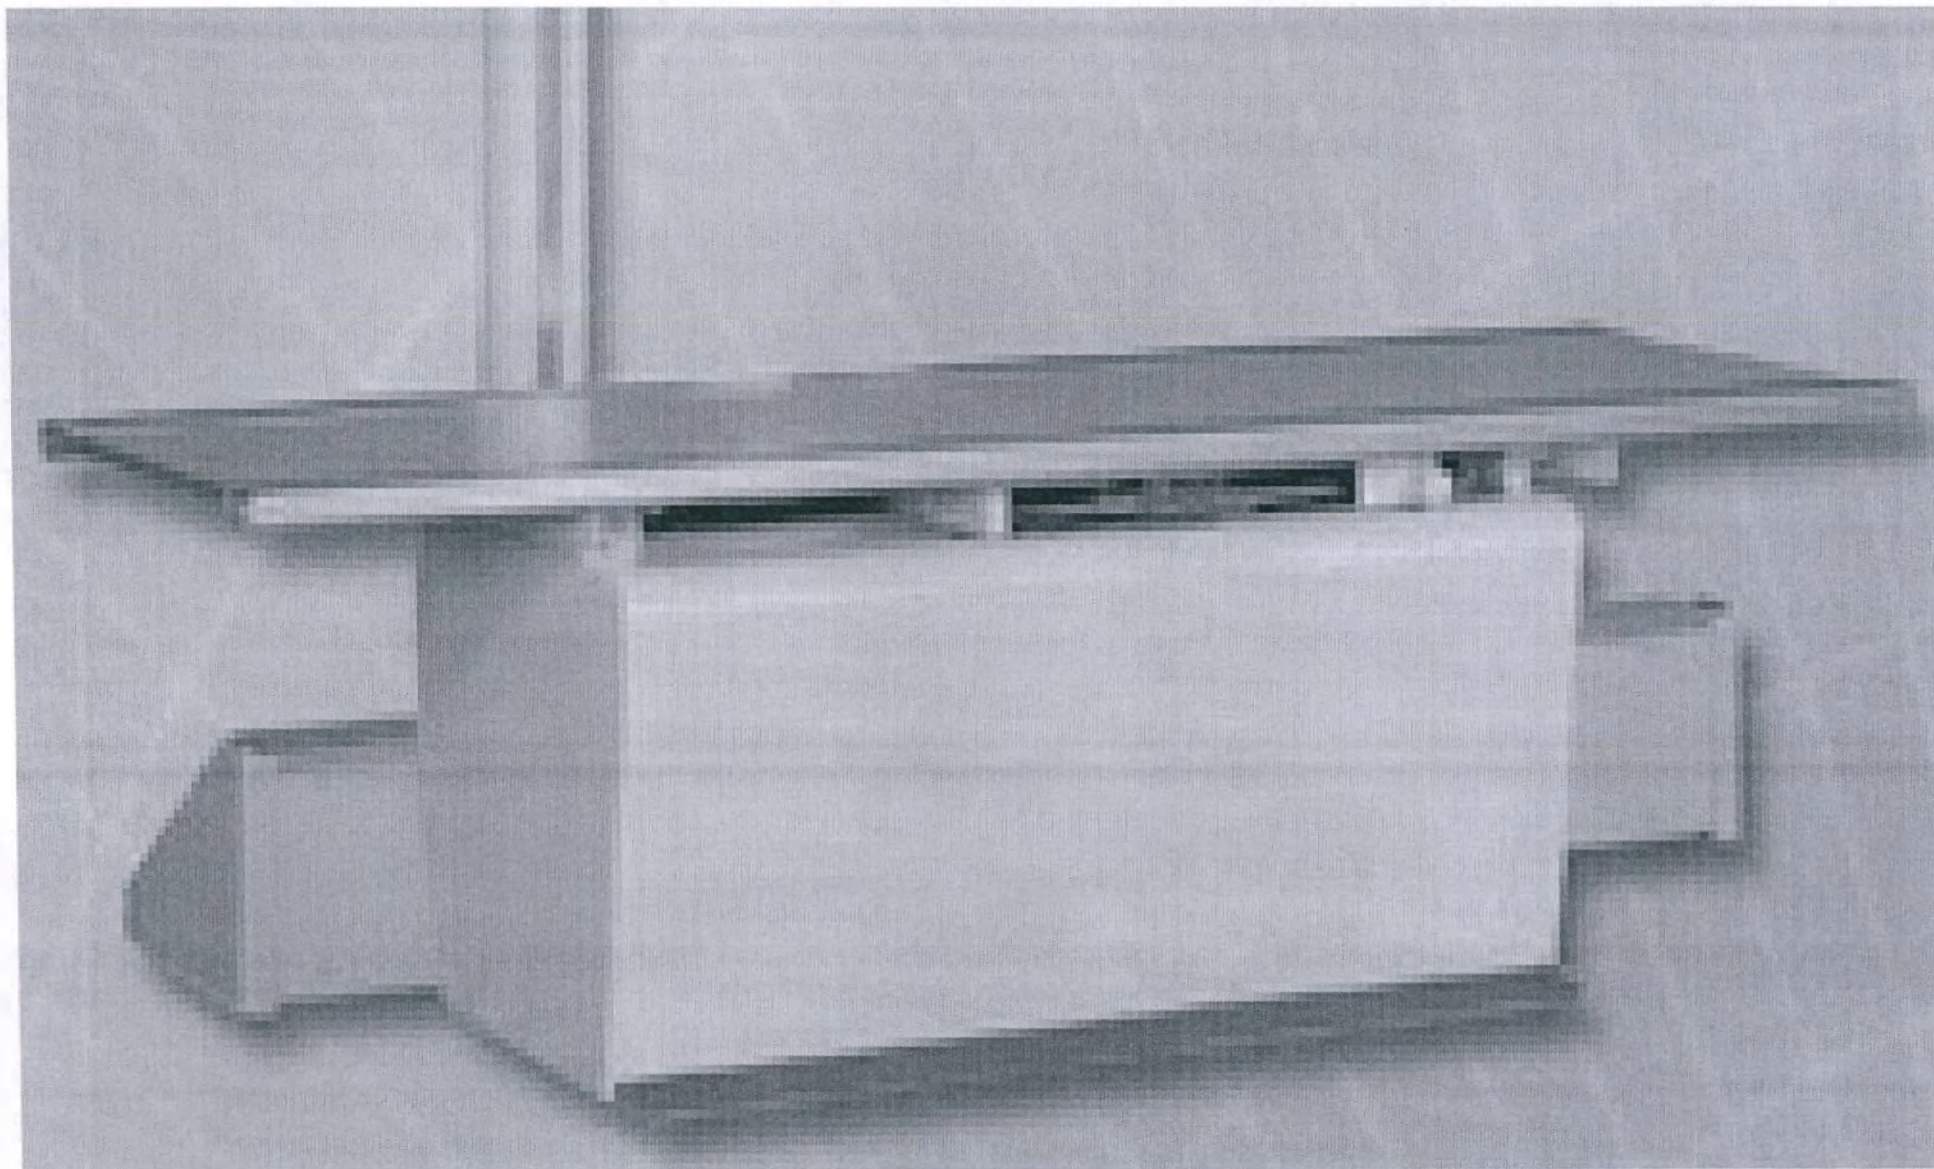


или производства Diagnostic Medical System Apelem, Франция;

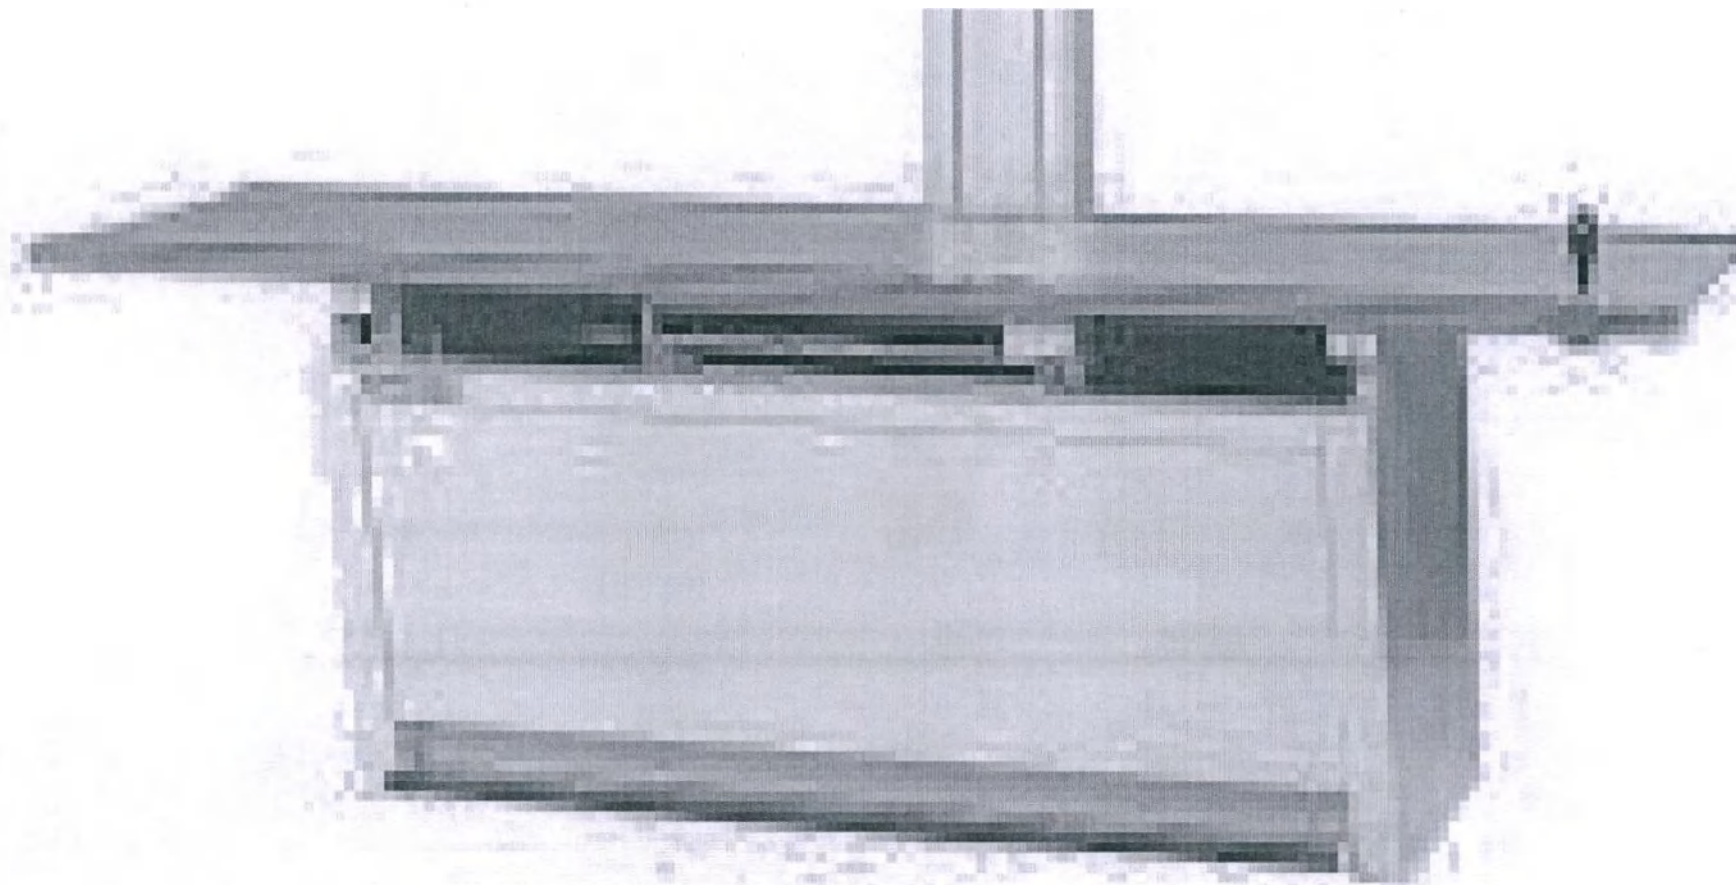

или АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

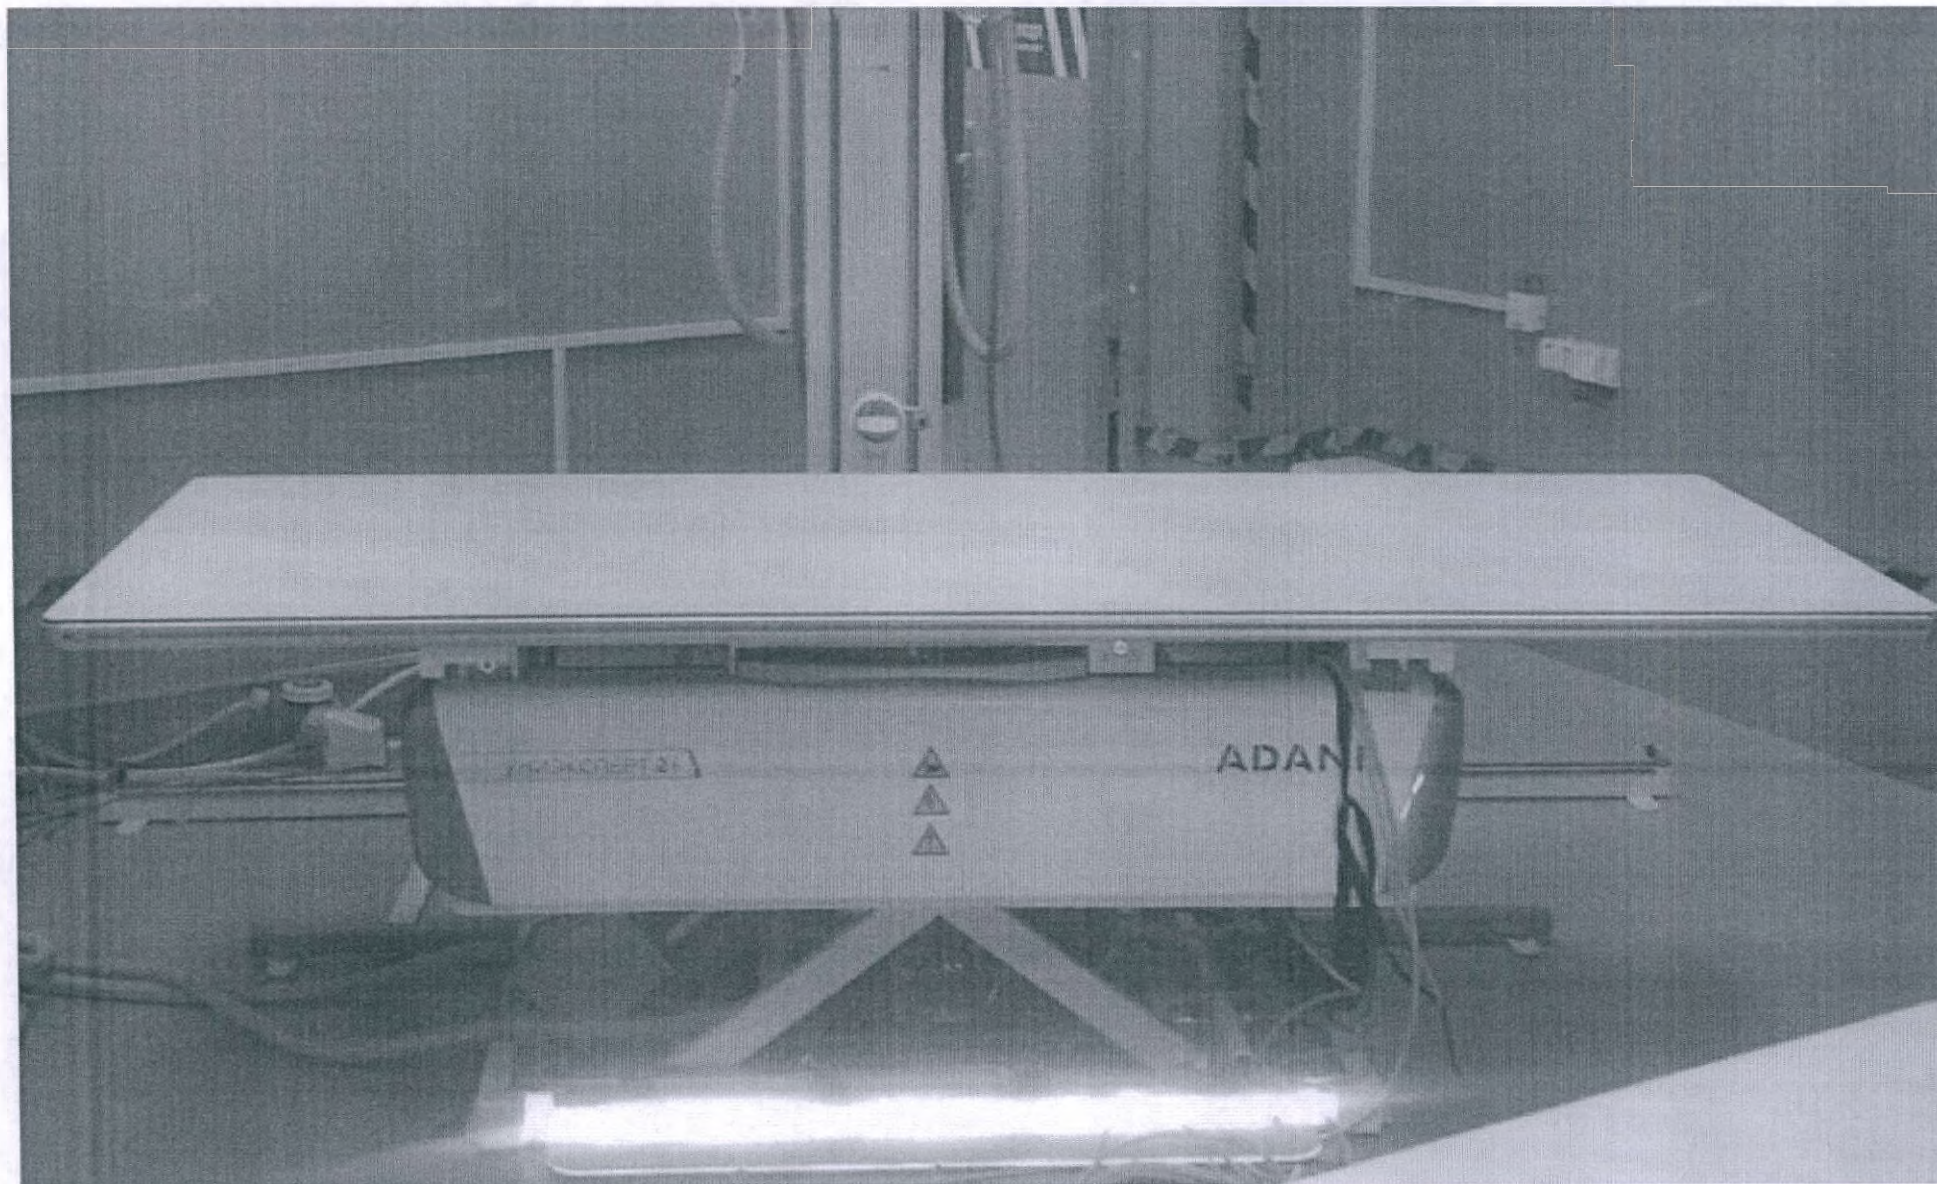


2. Рентгеновский излучатель Е; ЕХ производства Canon Medical System Corporation, Япония;

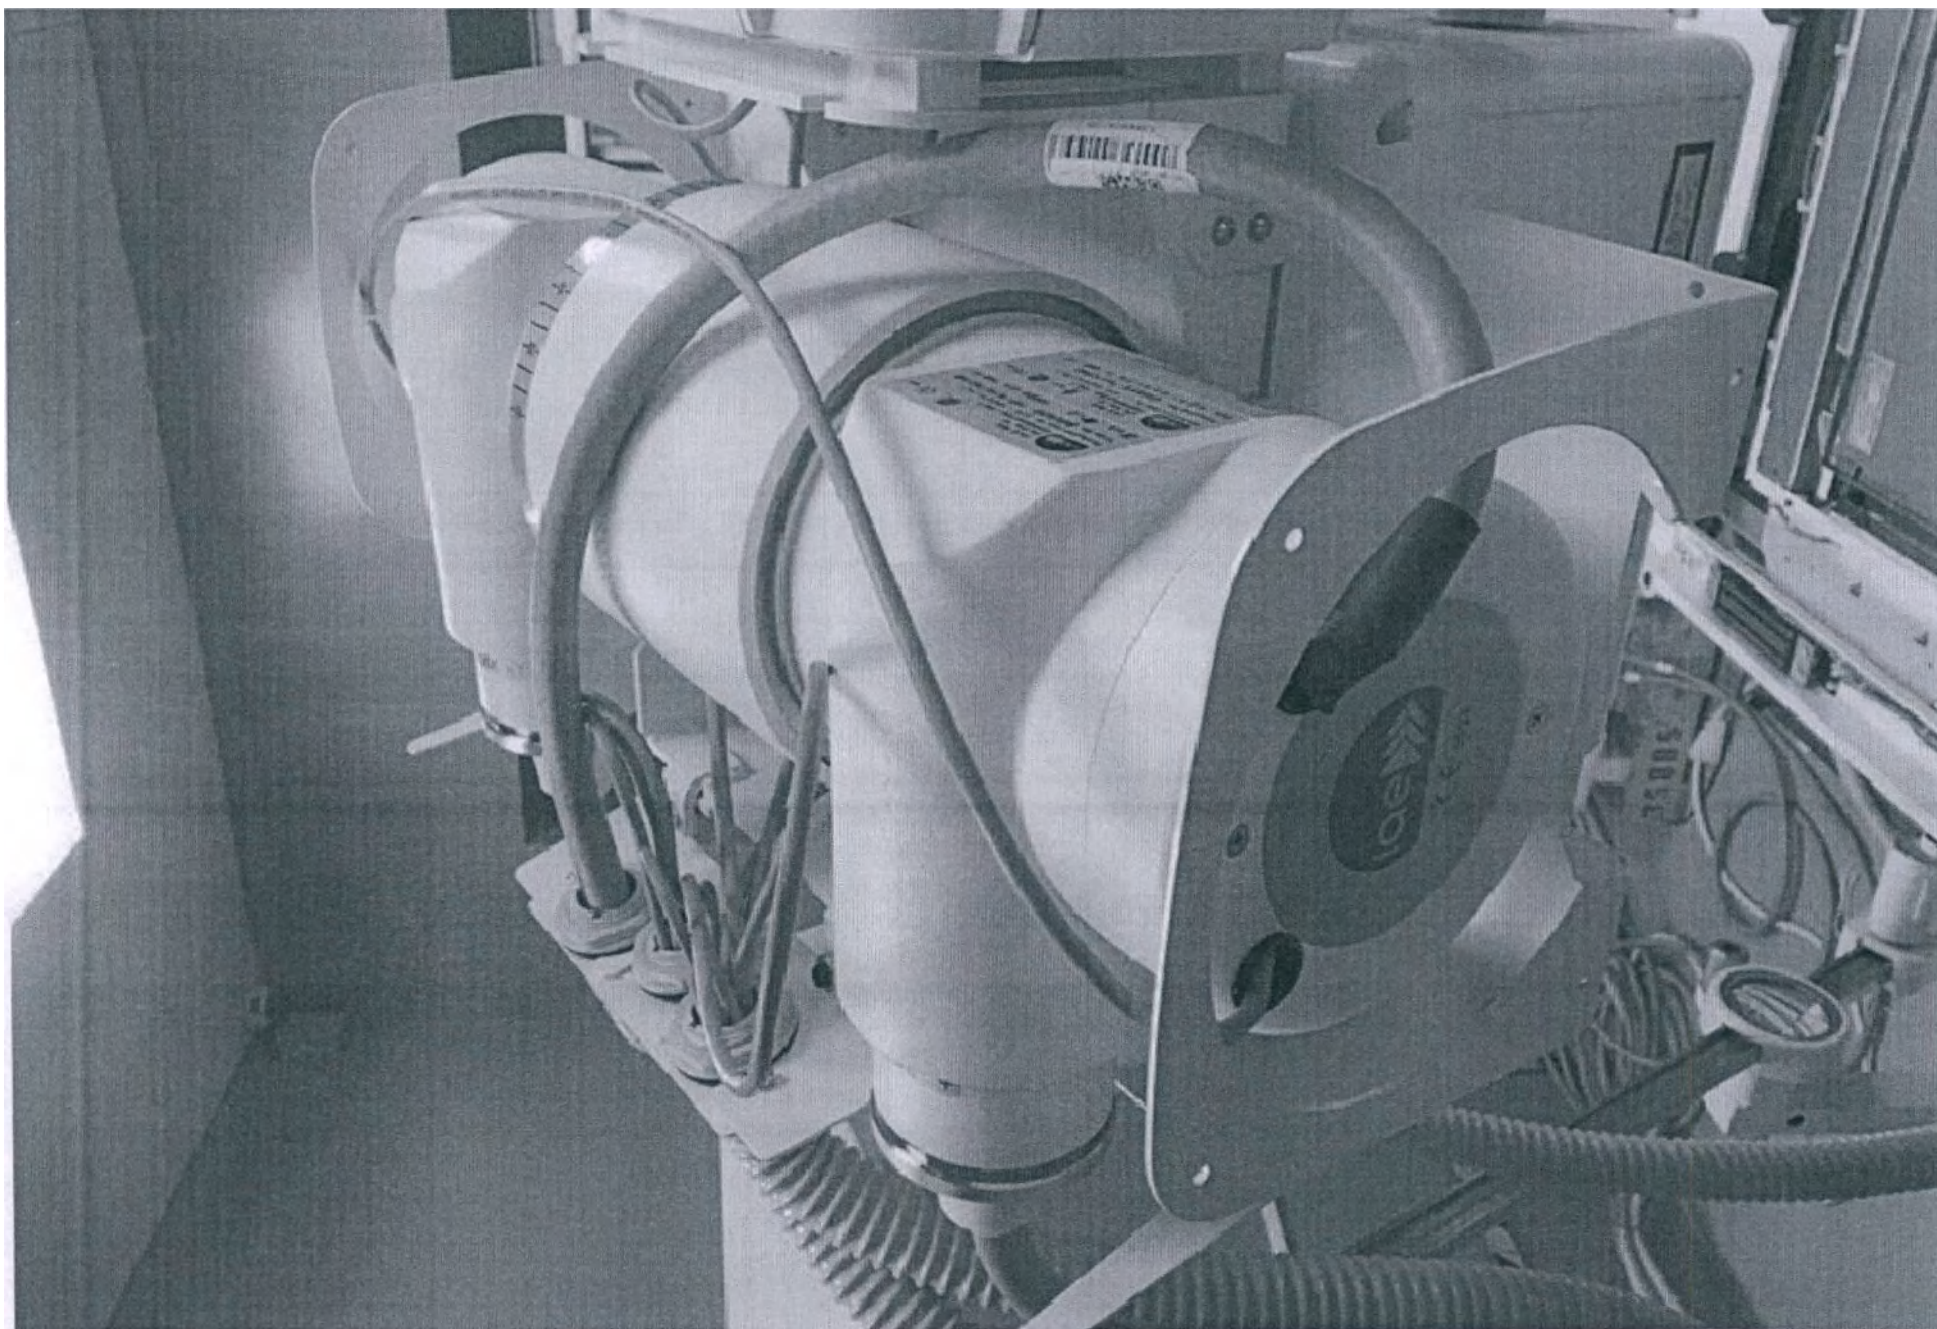


или X, RTM, RTC производства I.A.E Industria Applicazioni Elettroniche S.P.A., Италия;




или A; G; RAD; SG; Sapphire, Diamond, CGR производства Varex Imaging Corporation, США;

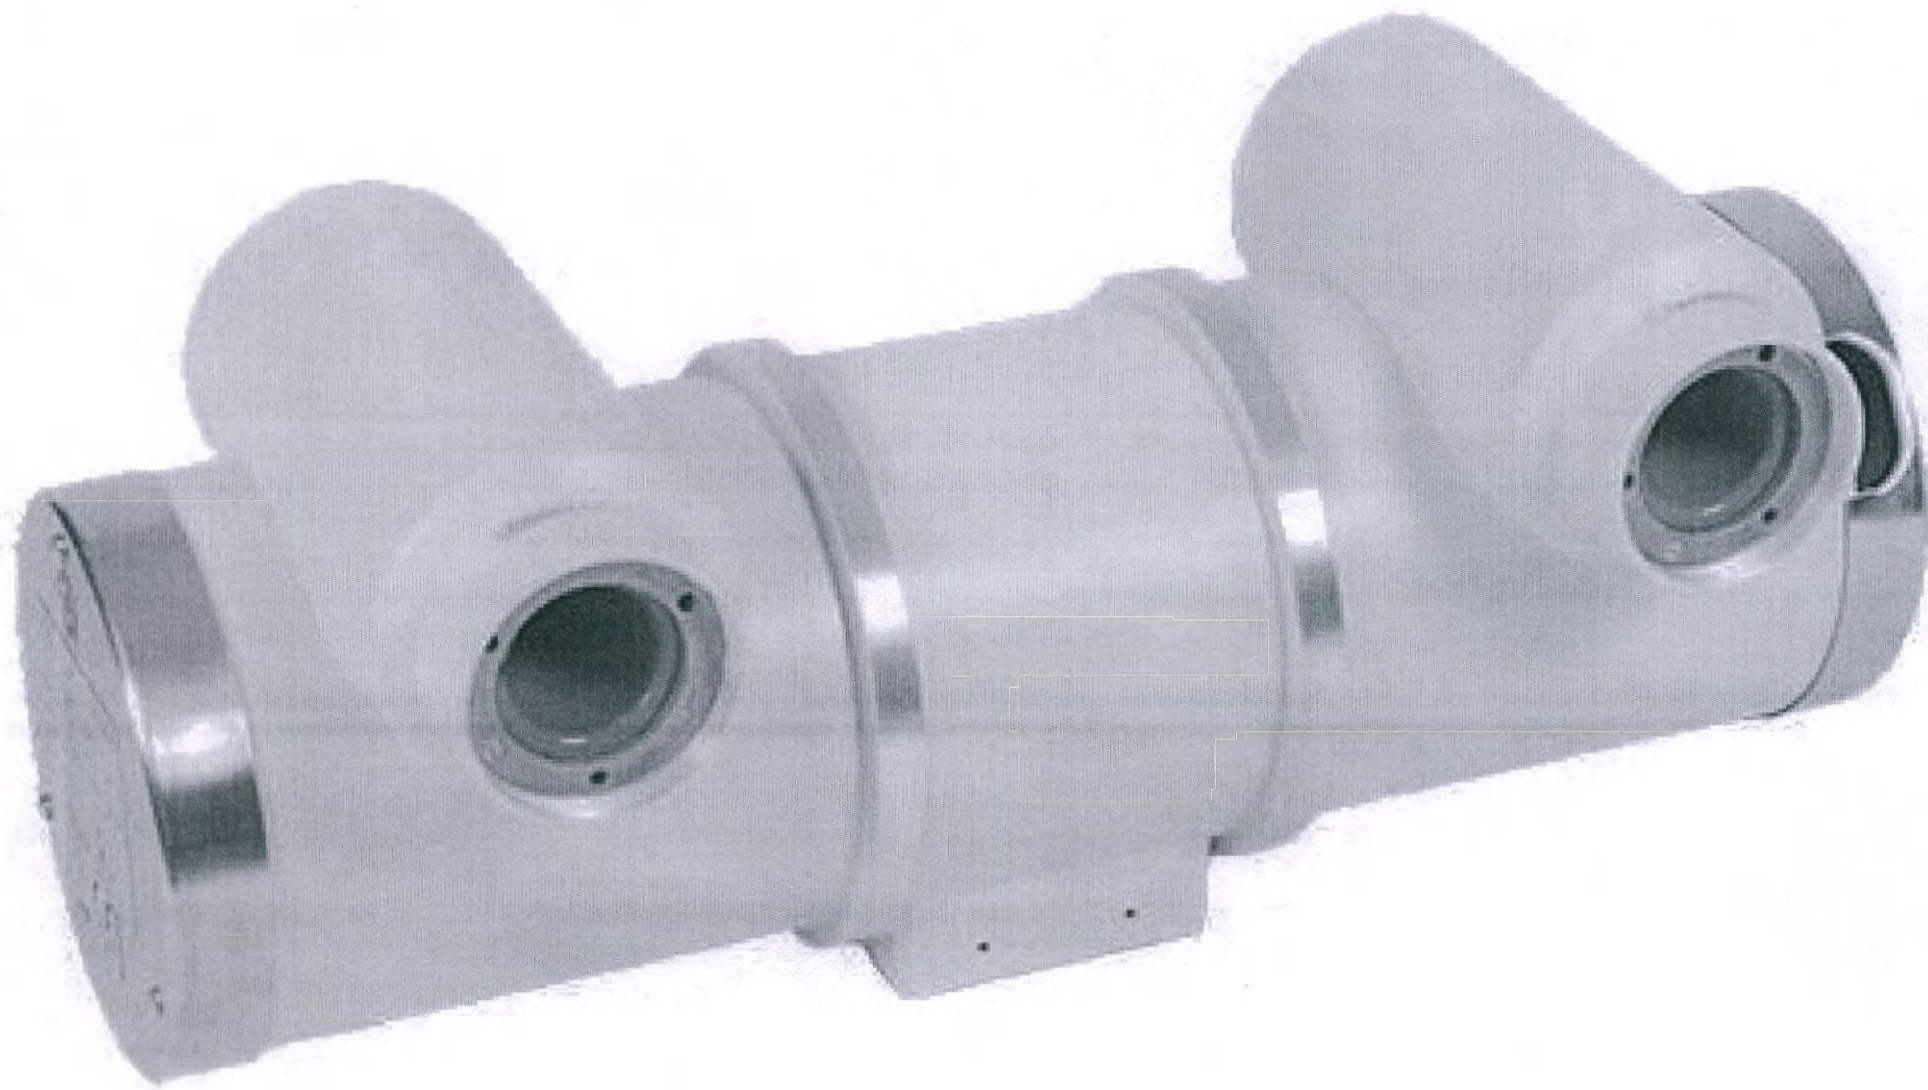


или Р 135/70; 135/30R; 125/10/20 CR производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

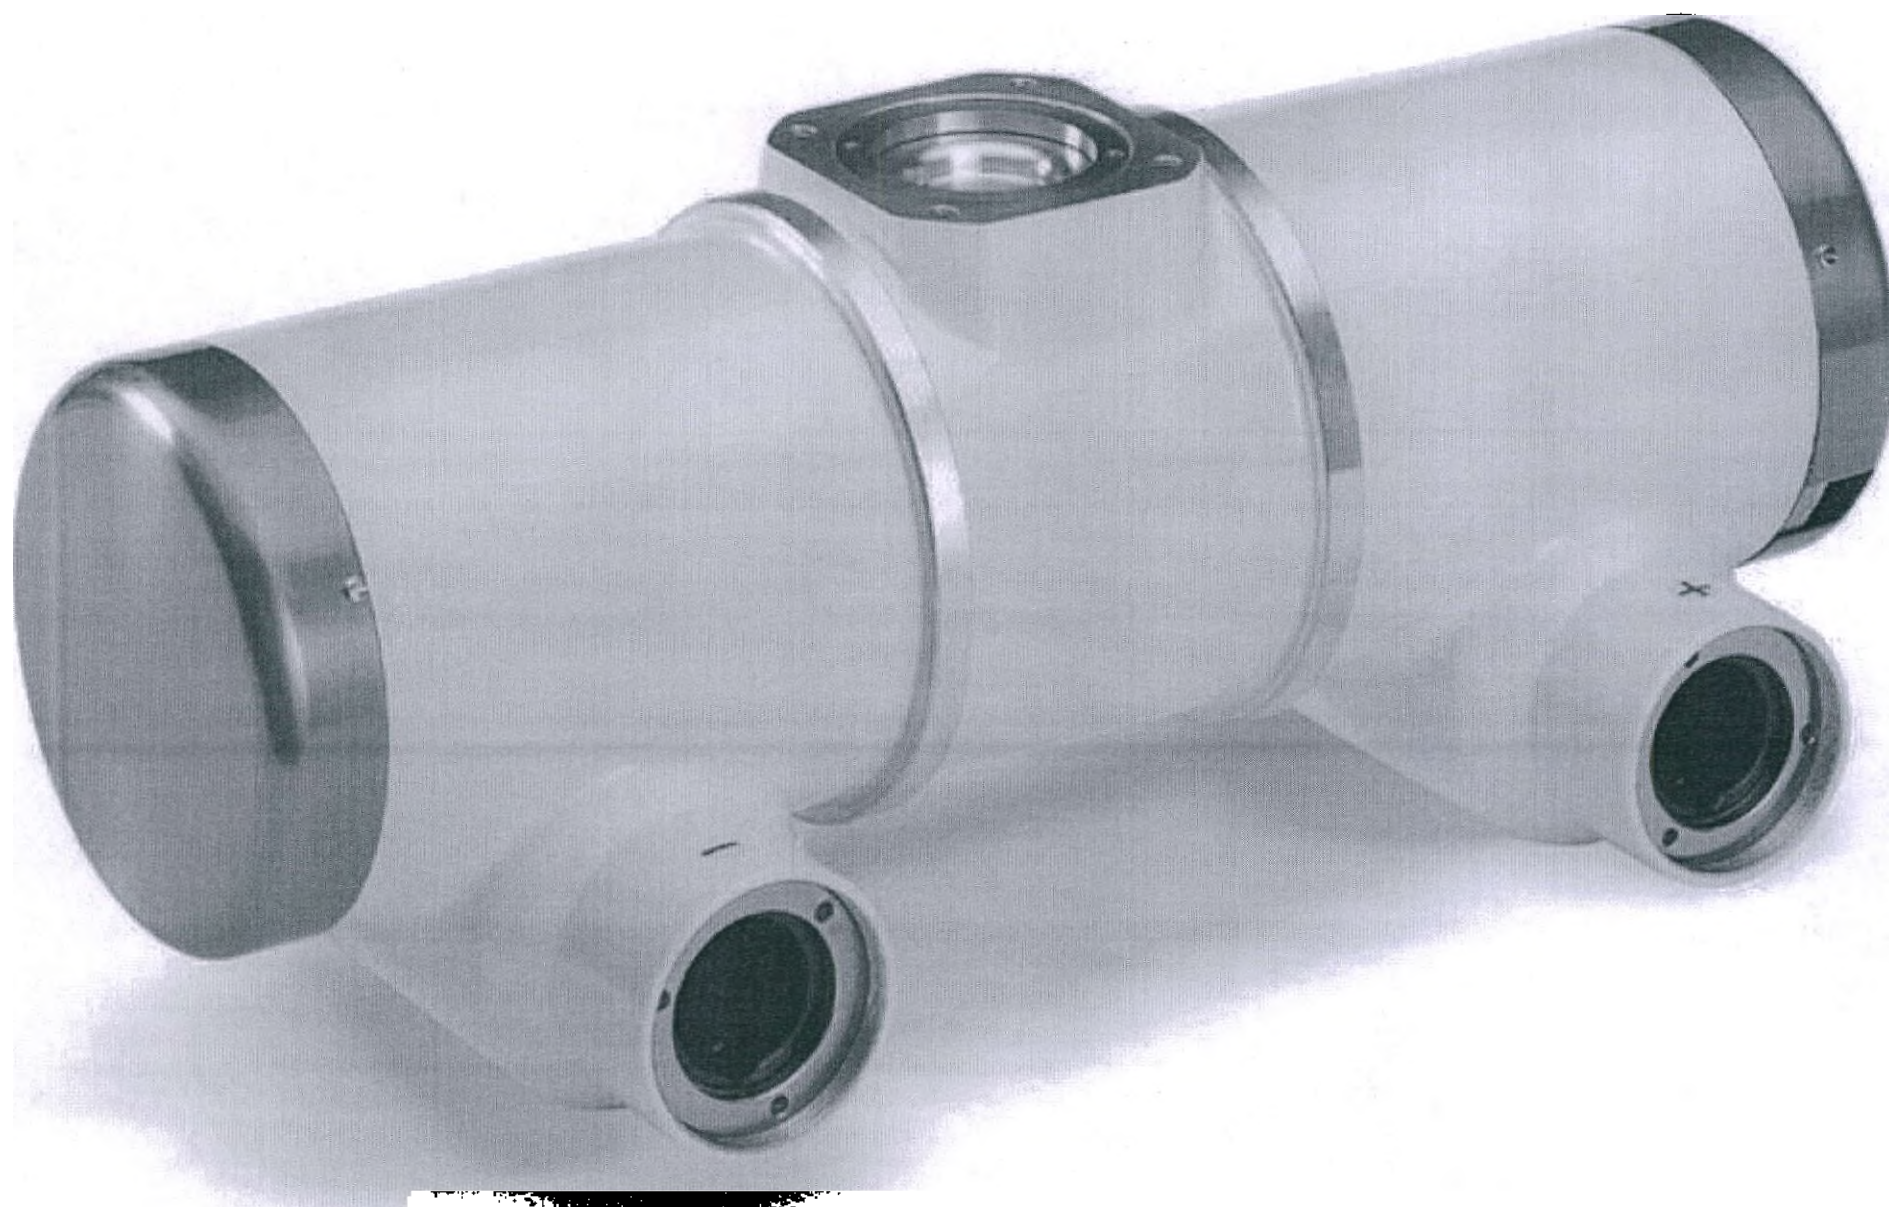


3. Кабели высоковольтные Cable Assy производства Varex Imaging Corporation, Филиппины и Нидерланды;

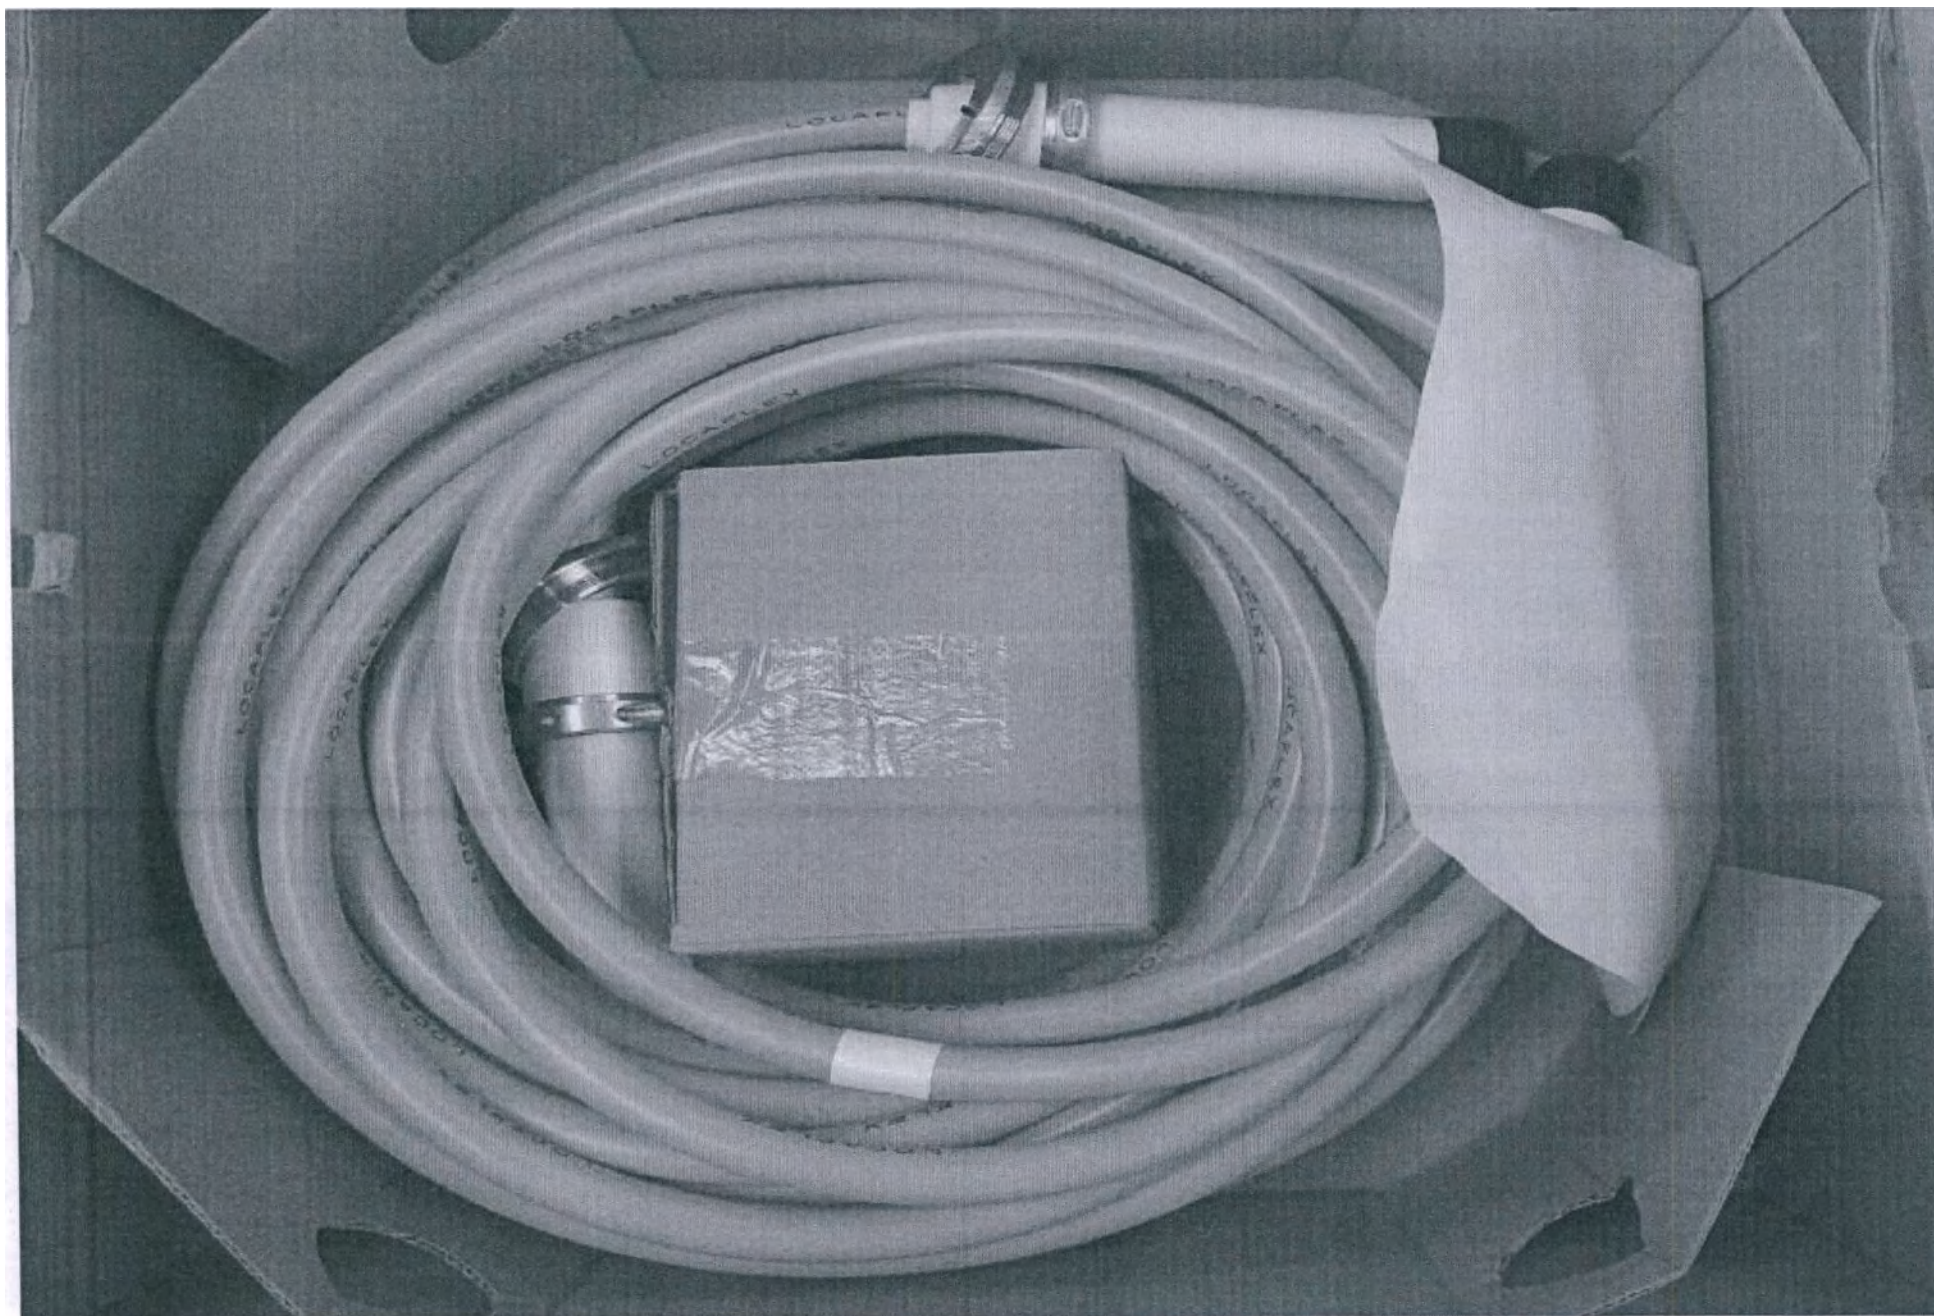


или Roesys HVC, производства Roesys GmbH, Германия; или производства Comet AG, Швейцария.

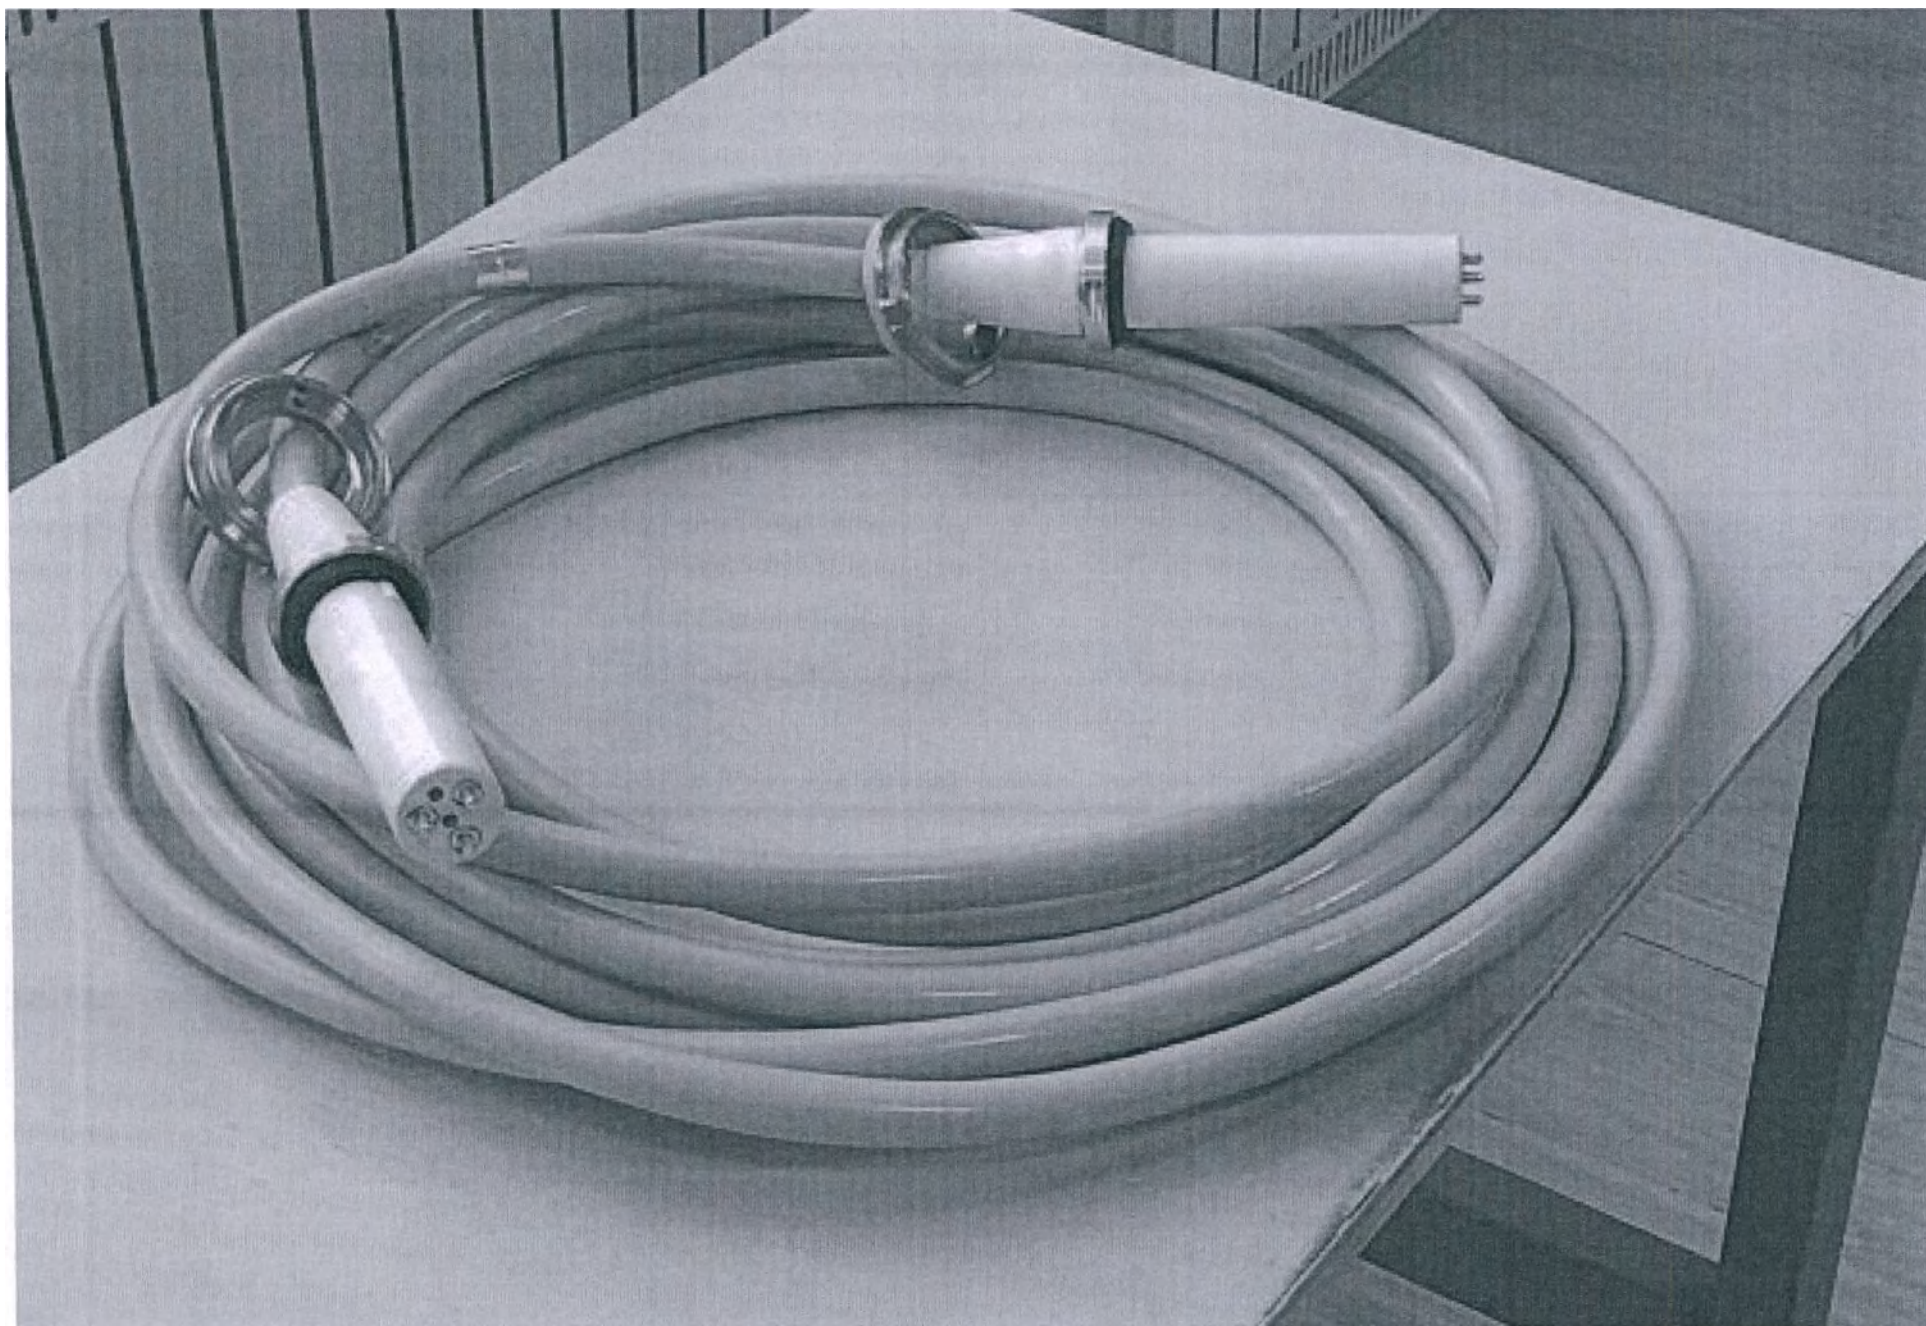

4. Колонна опорная для рентгеновского излучателя IMX производства Imago Radiology S.r.l. Италия;

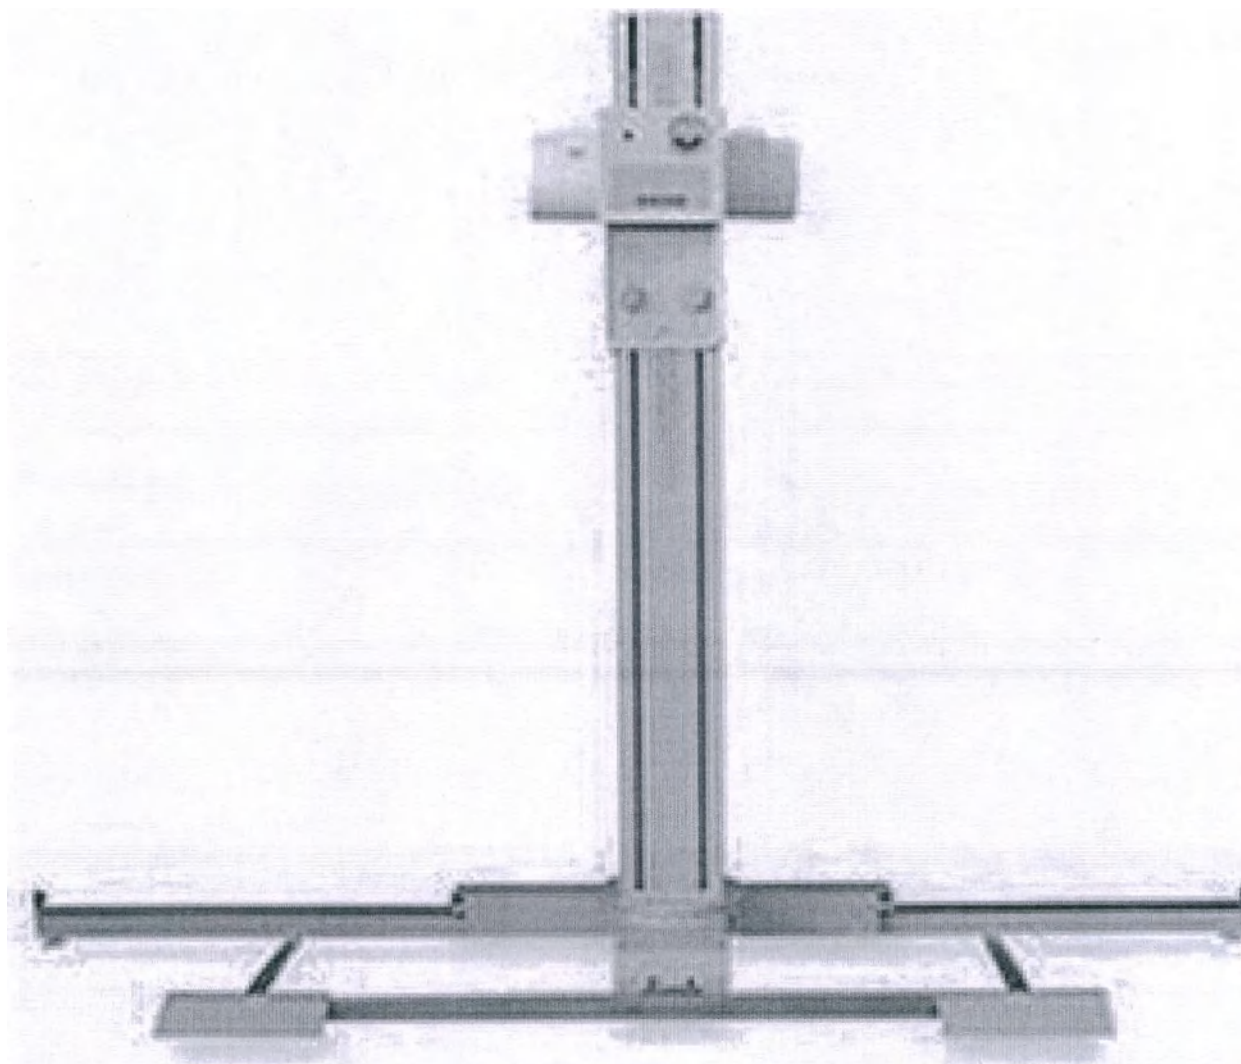


или Millenium производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания;

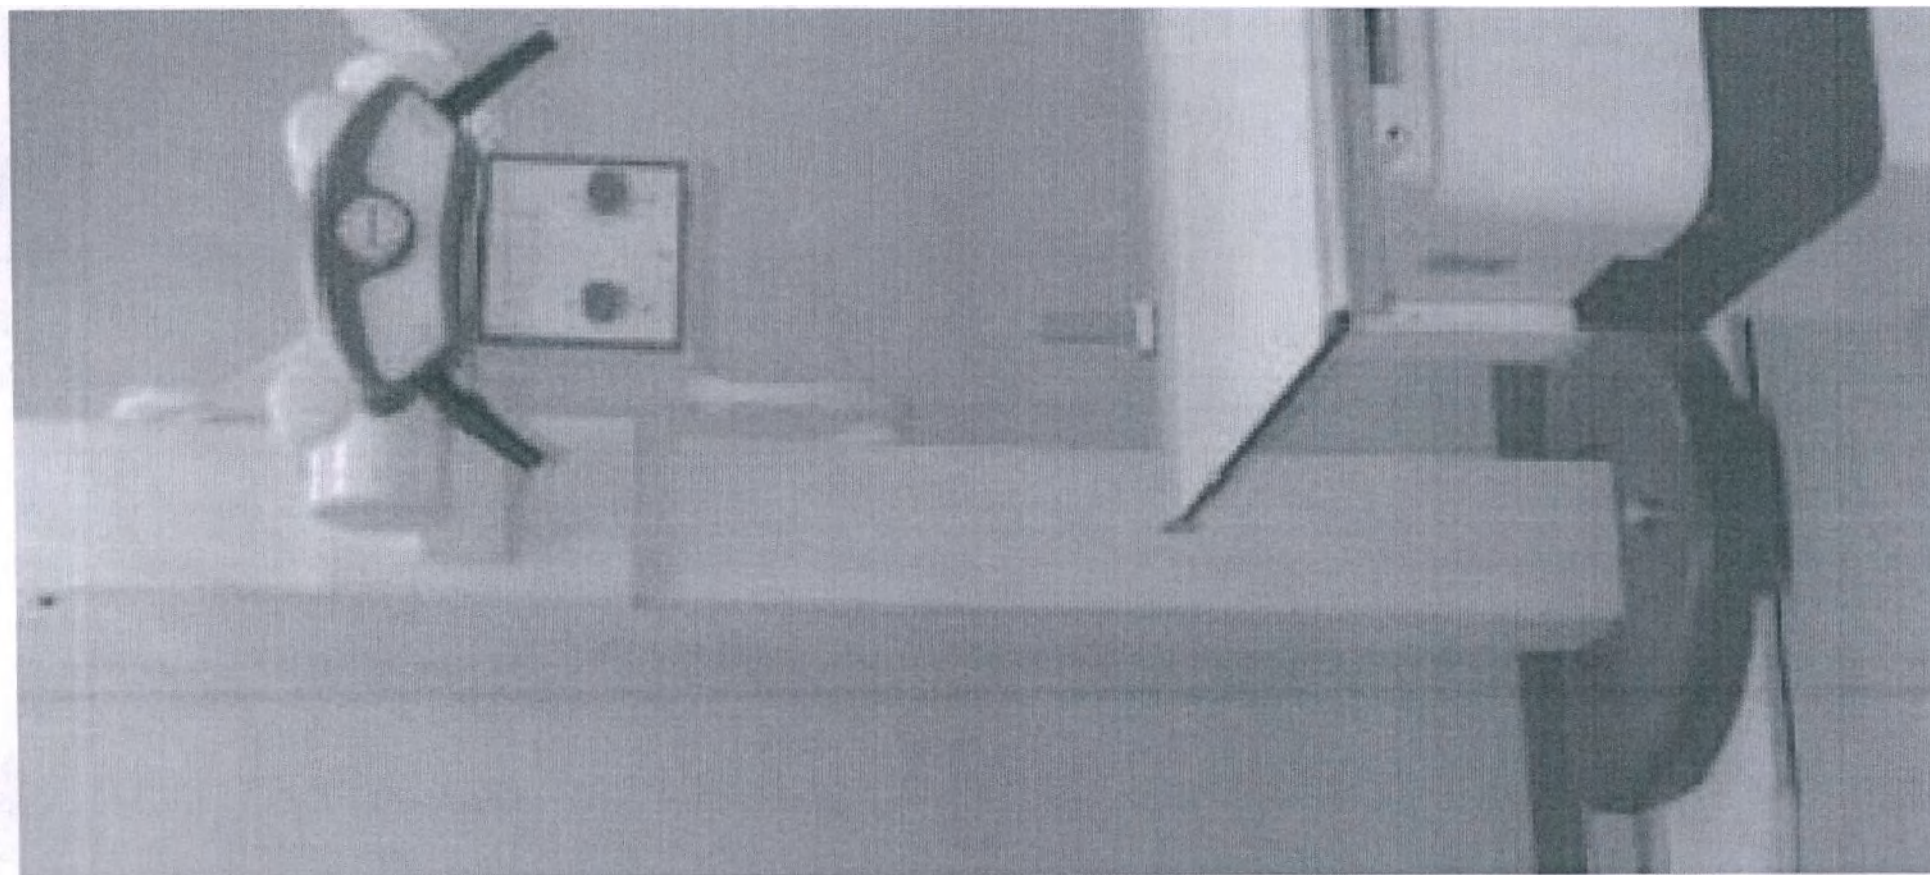


или МСР производства General Medical Merate SPA (GMM), Италия;



или АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

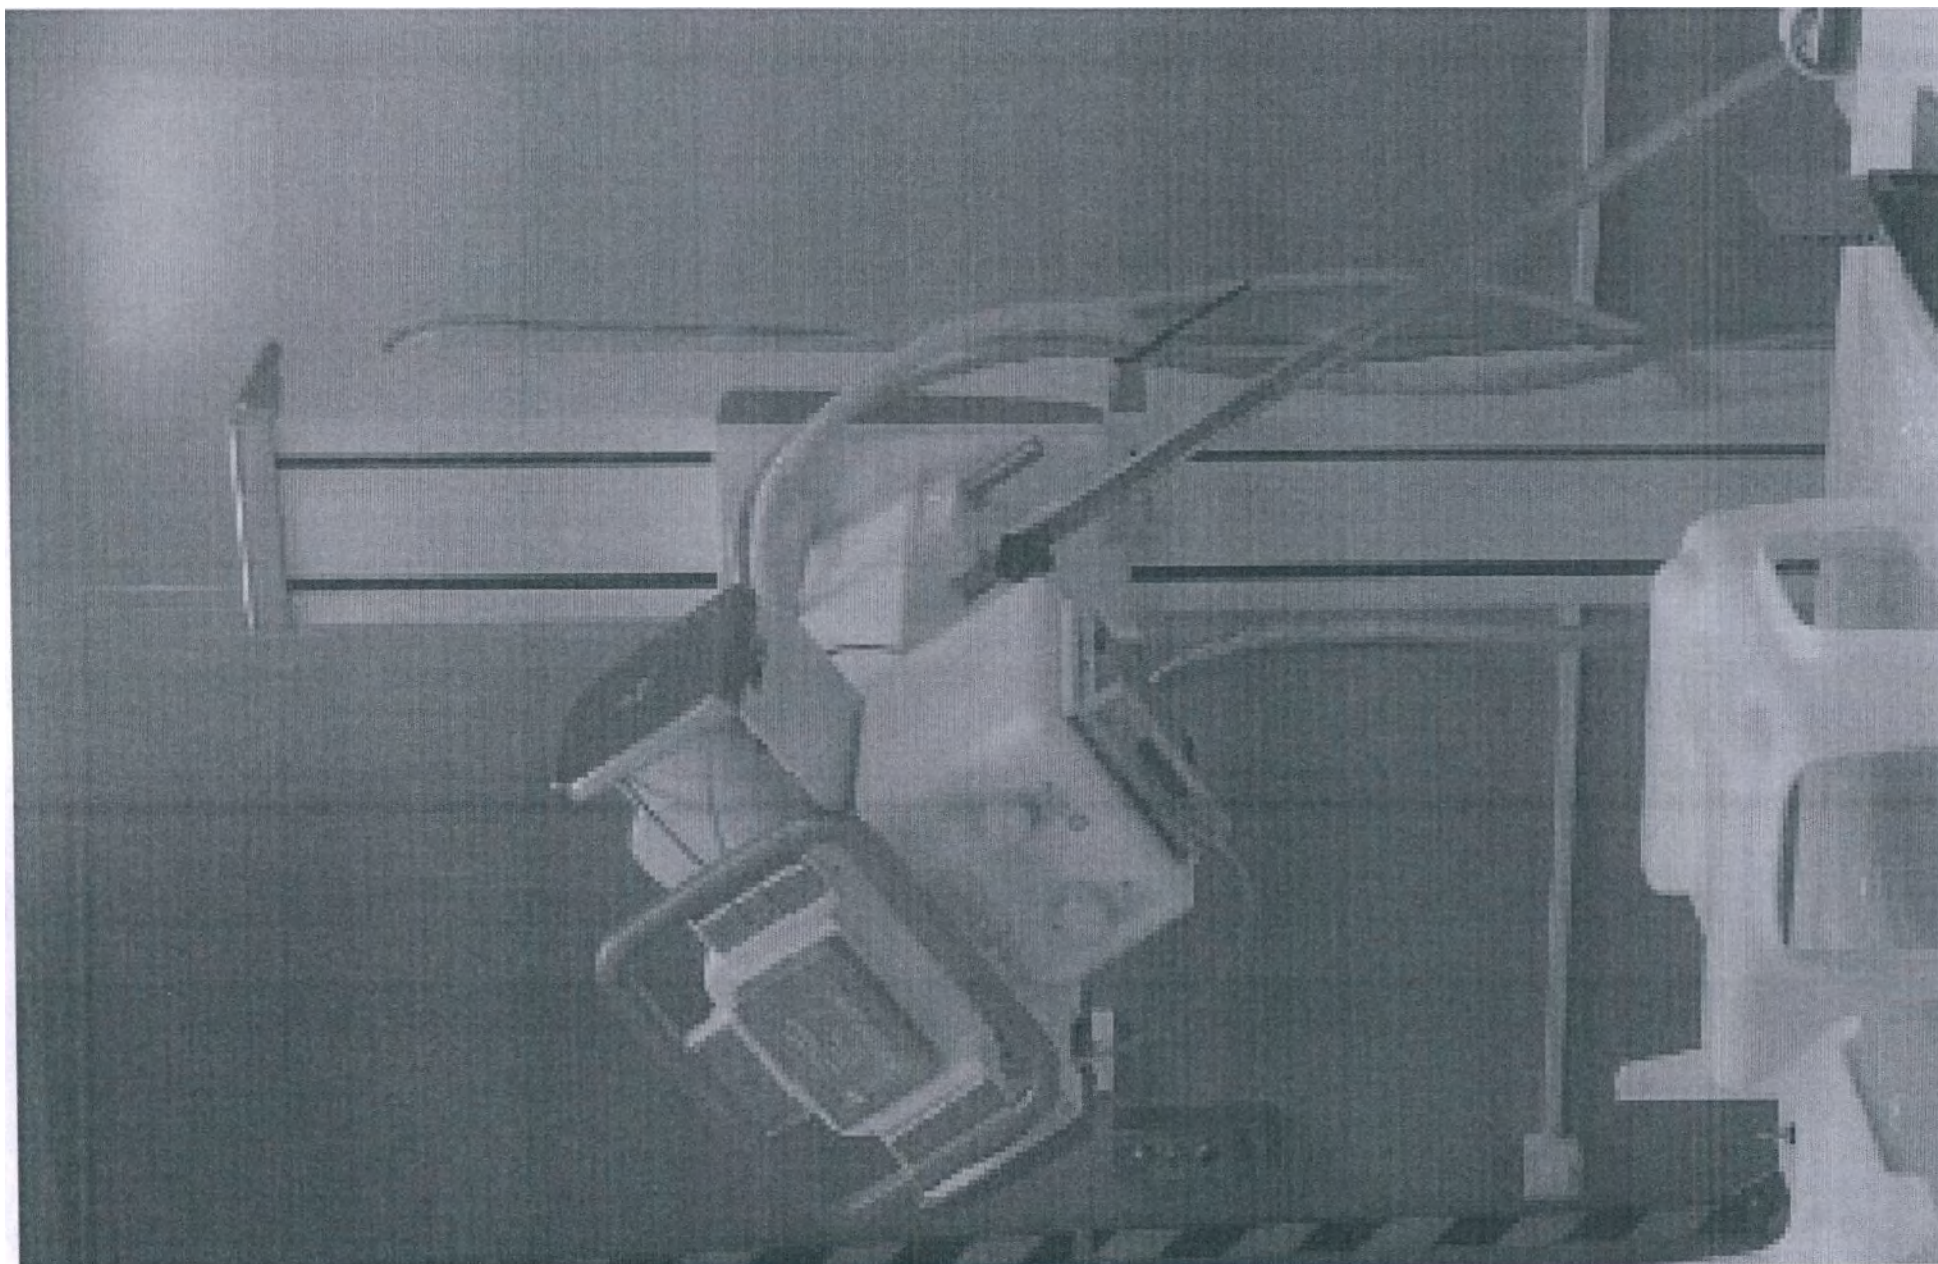


или производства Diagnostic Medical System Apelem, Франция.

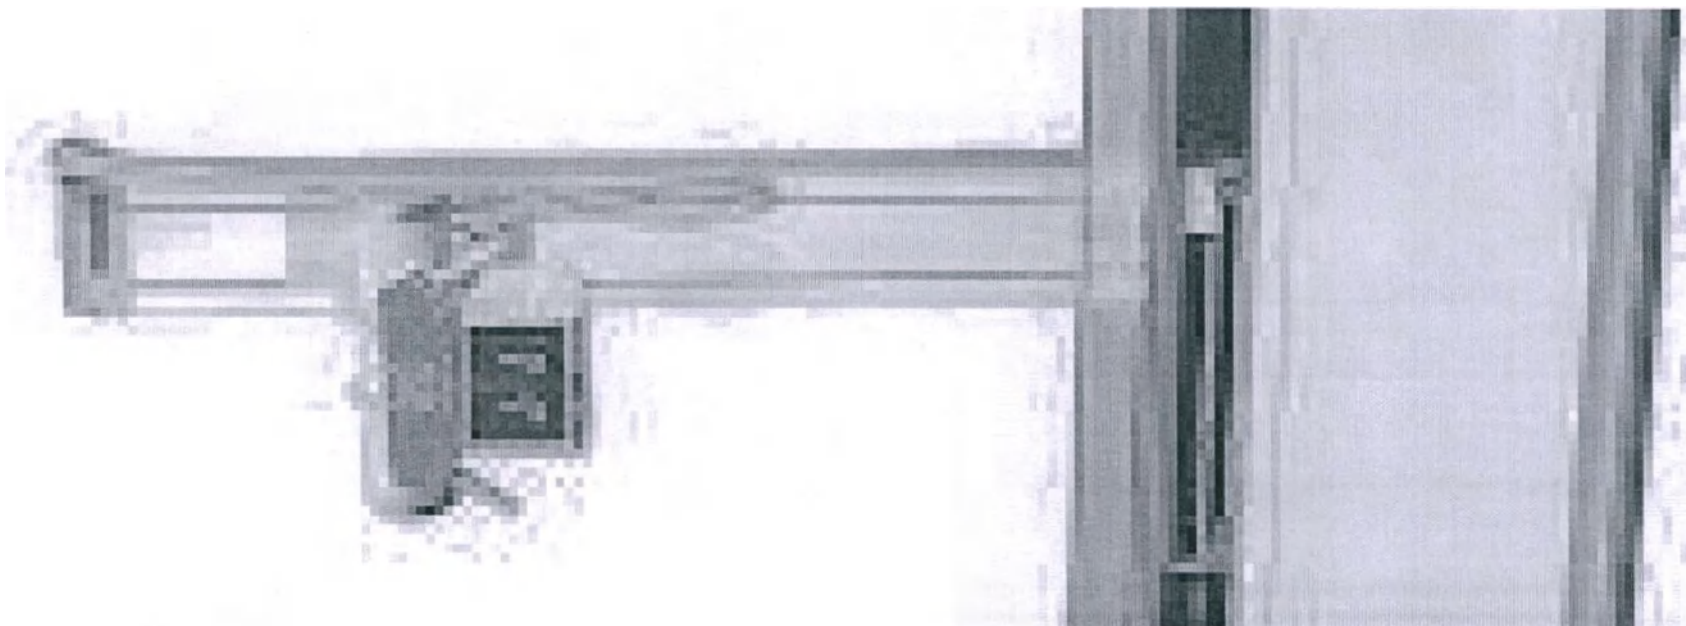


или СМ производства Huestis Medical, США;




или ML; AL; A; AF; AFL производства Siemens Healthcare GmbH, Германия;

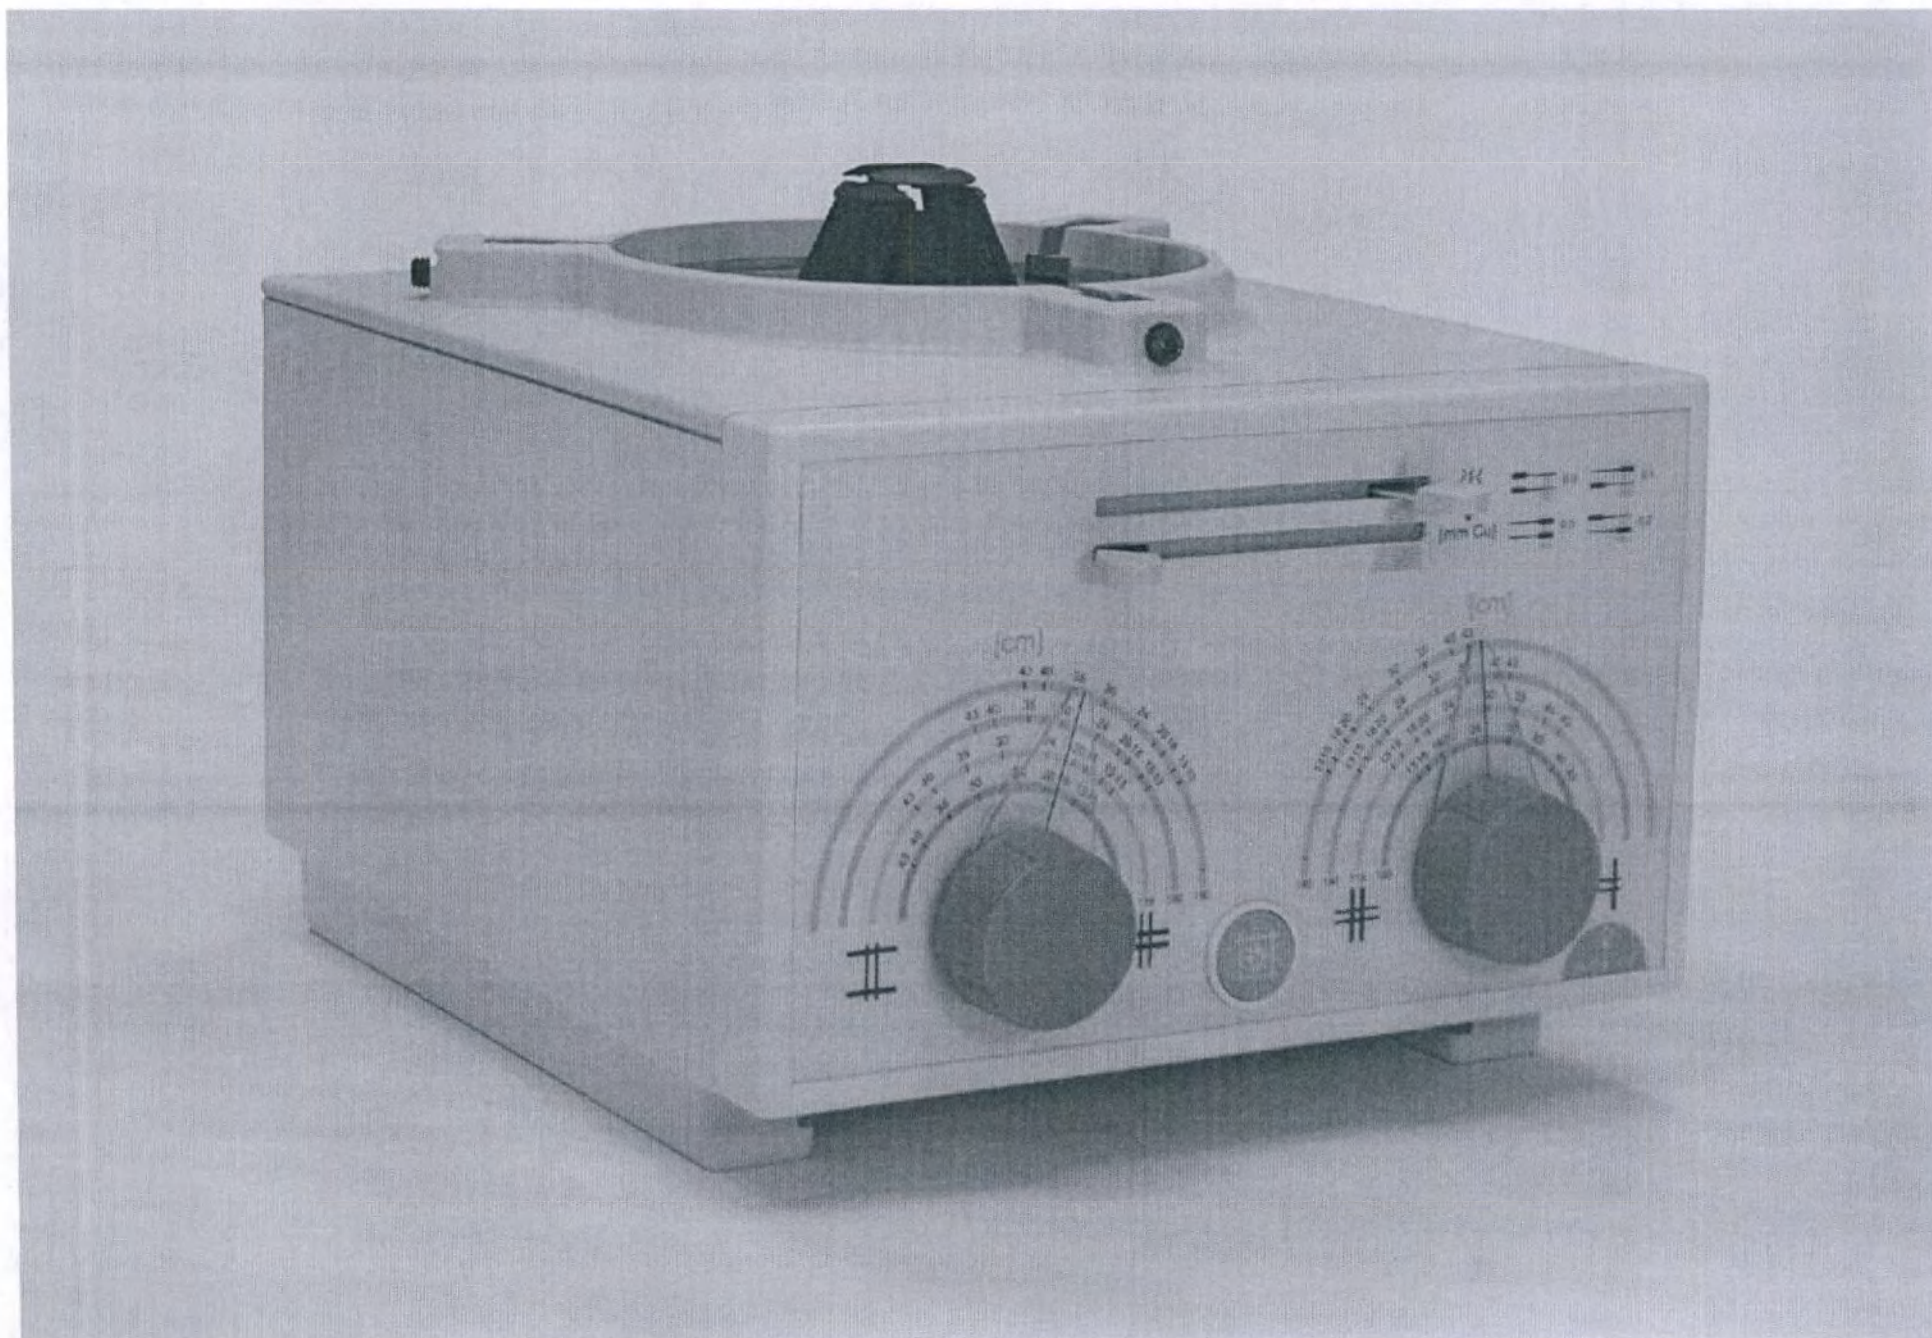


или Optica производства Varex Imaging Corporation, США

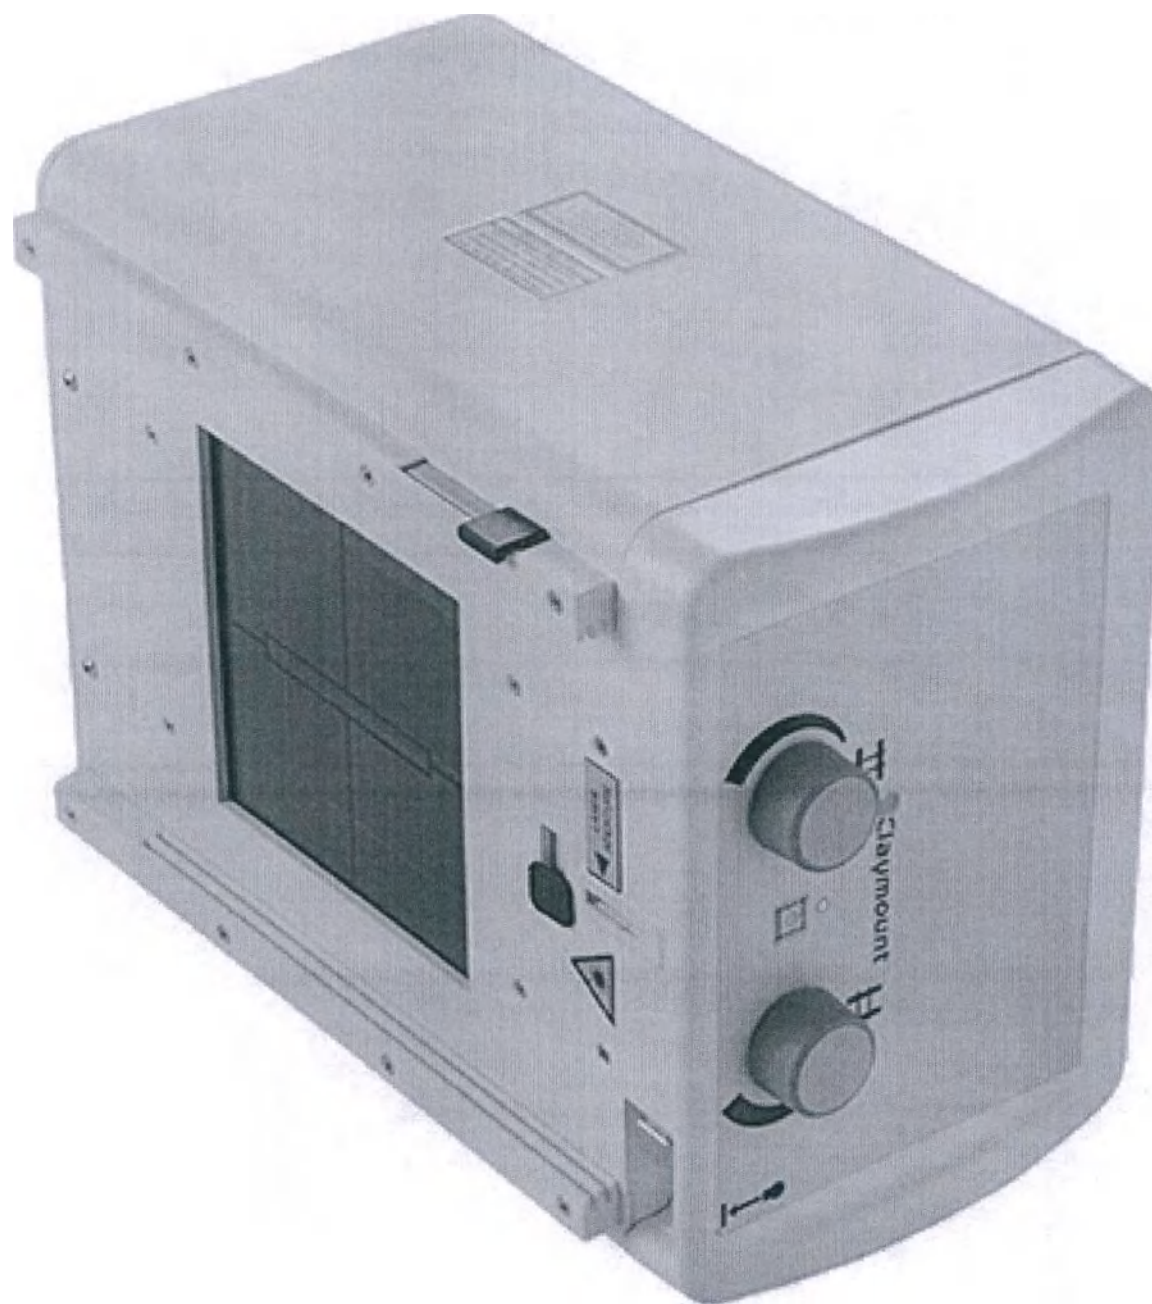


6. Устройство питающее рентгеновское, высокочастотное SHF, HF; SHFR производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания (РУ № ФСЗ 2009/04840);

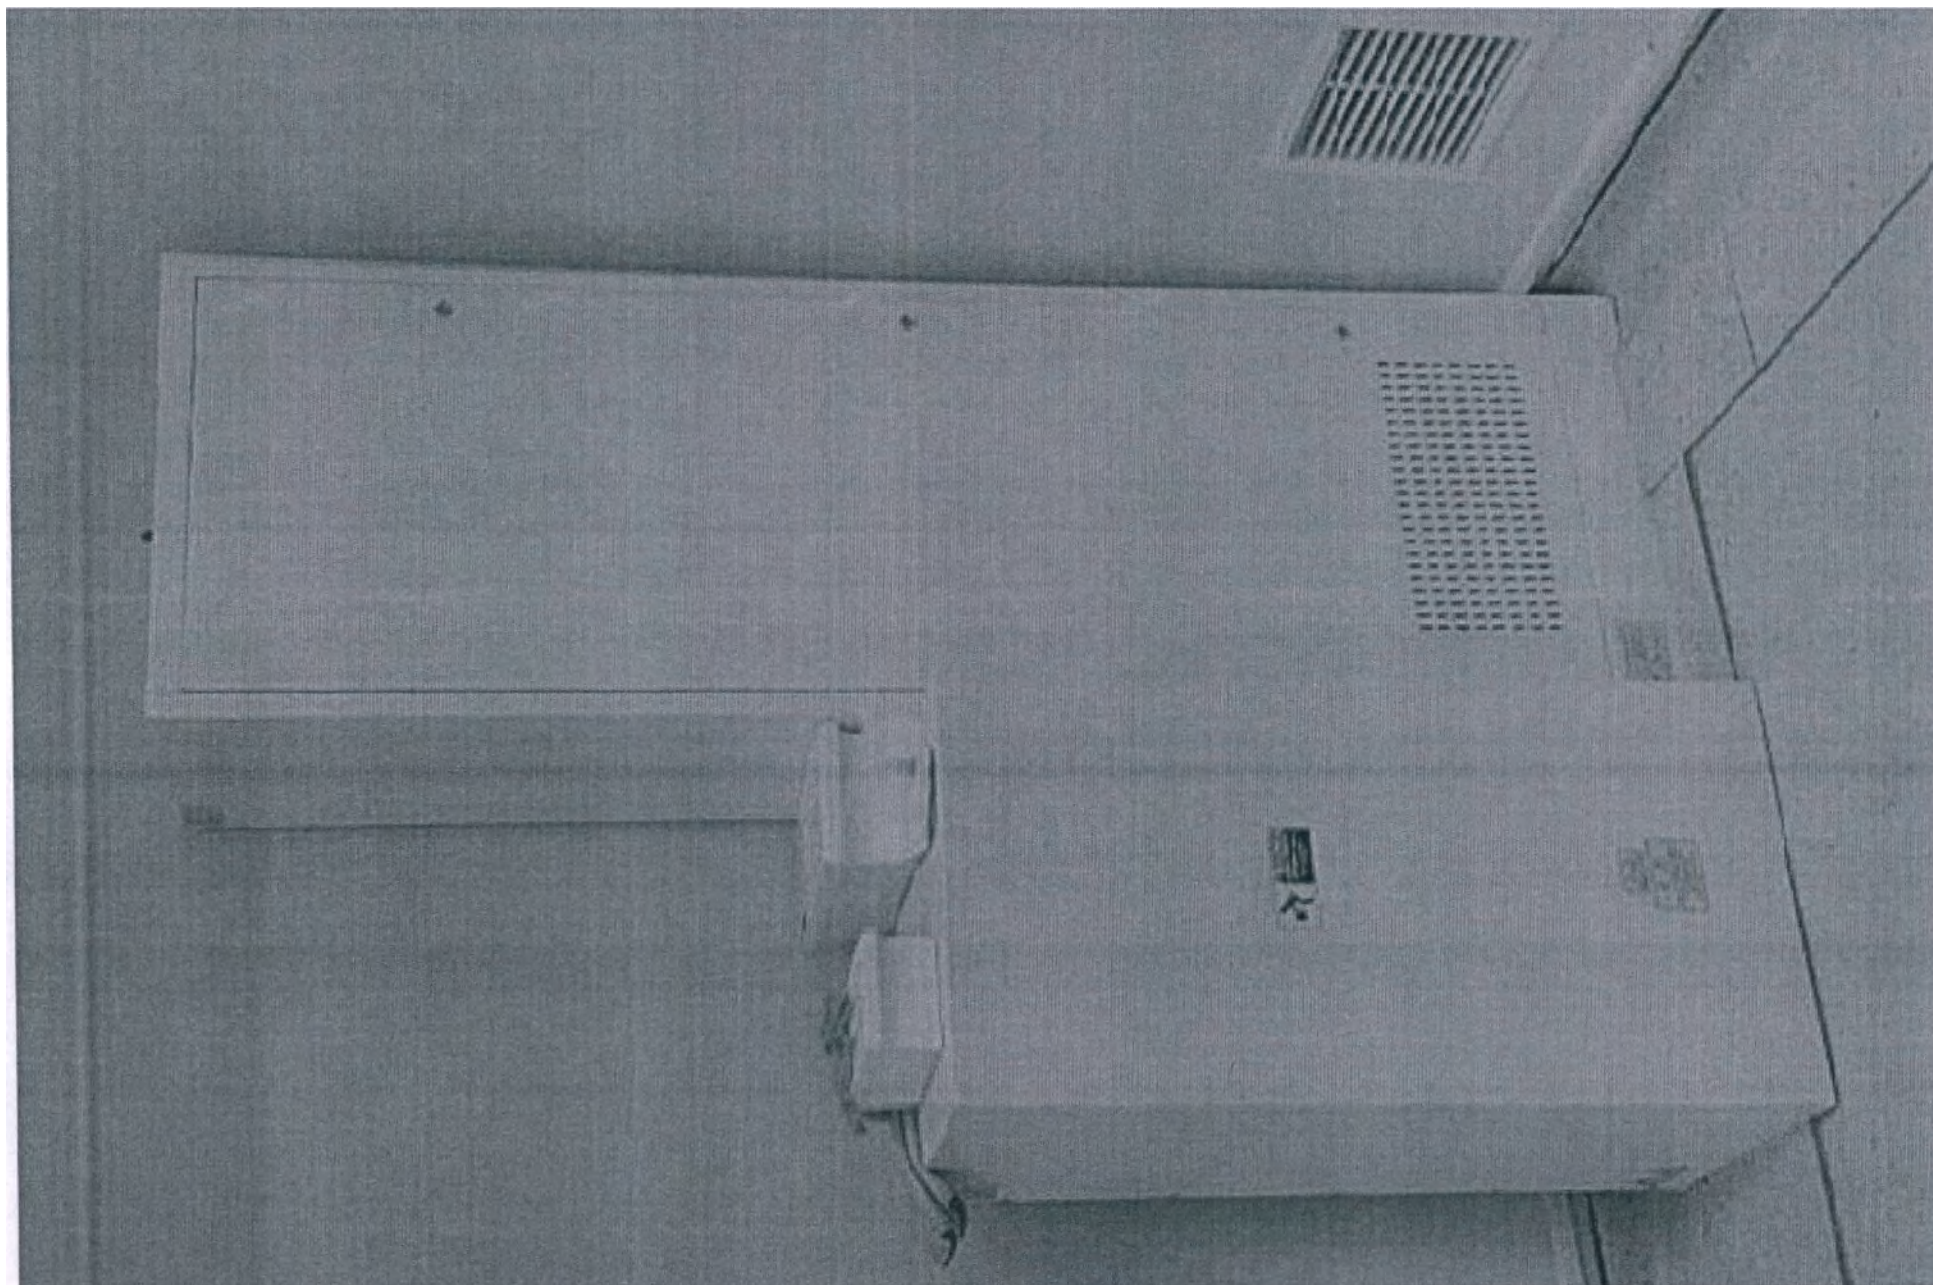

или EPS, EPS EVO производства EMD Technologies LLC, Канада;

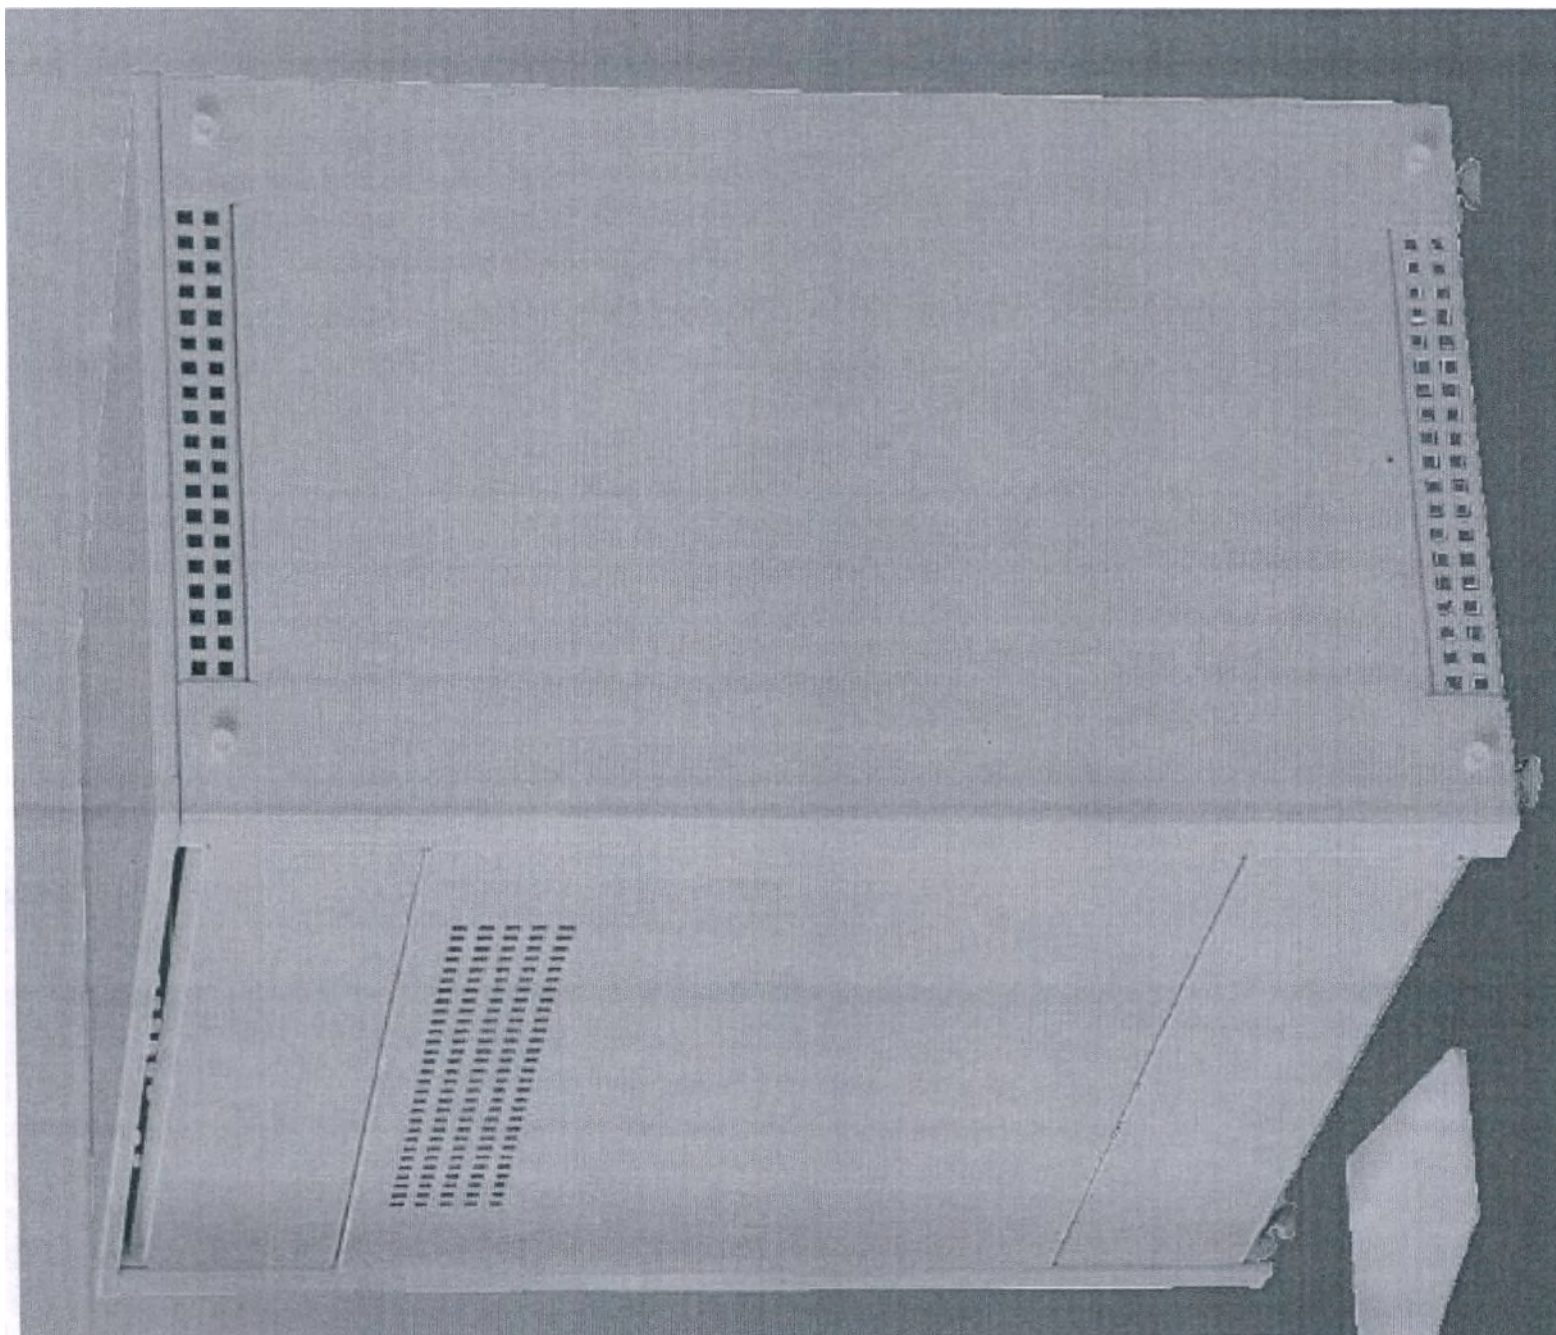


или Indico, СМР производства Communications & Power Industries Canada, Inc., Канада;

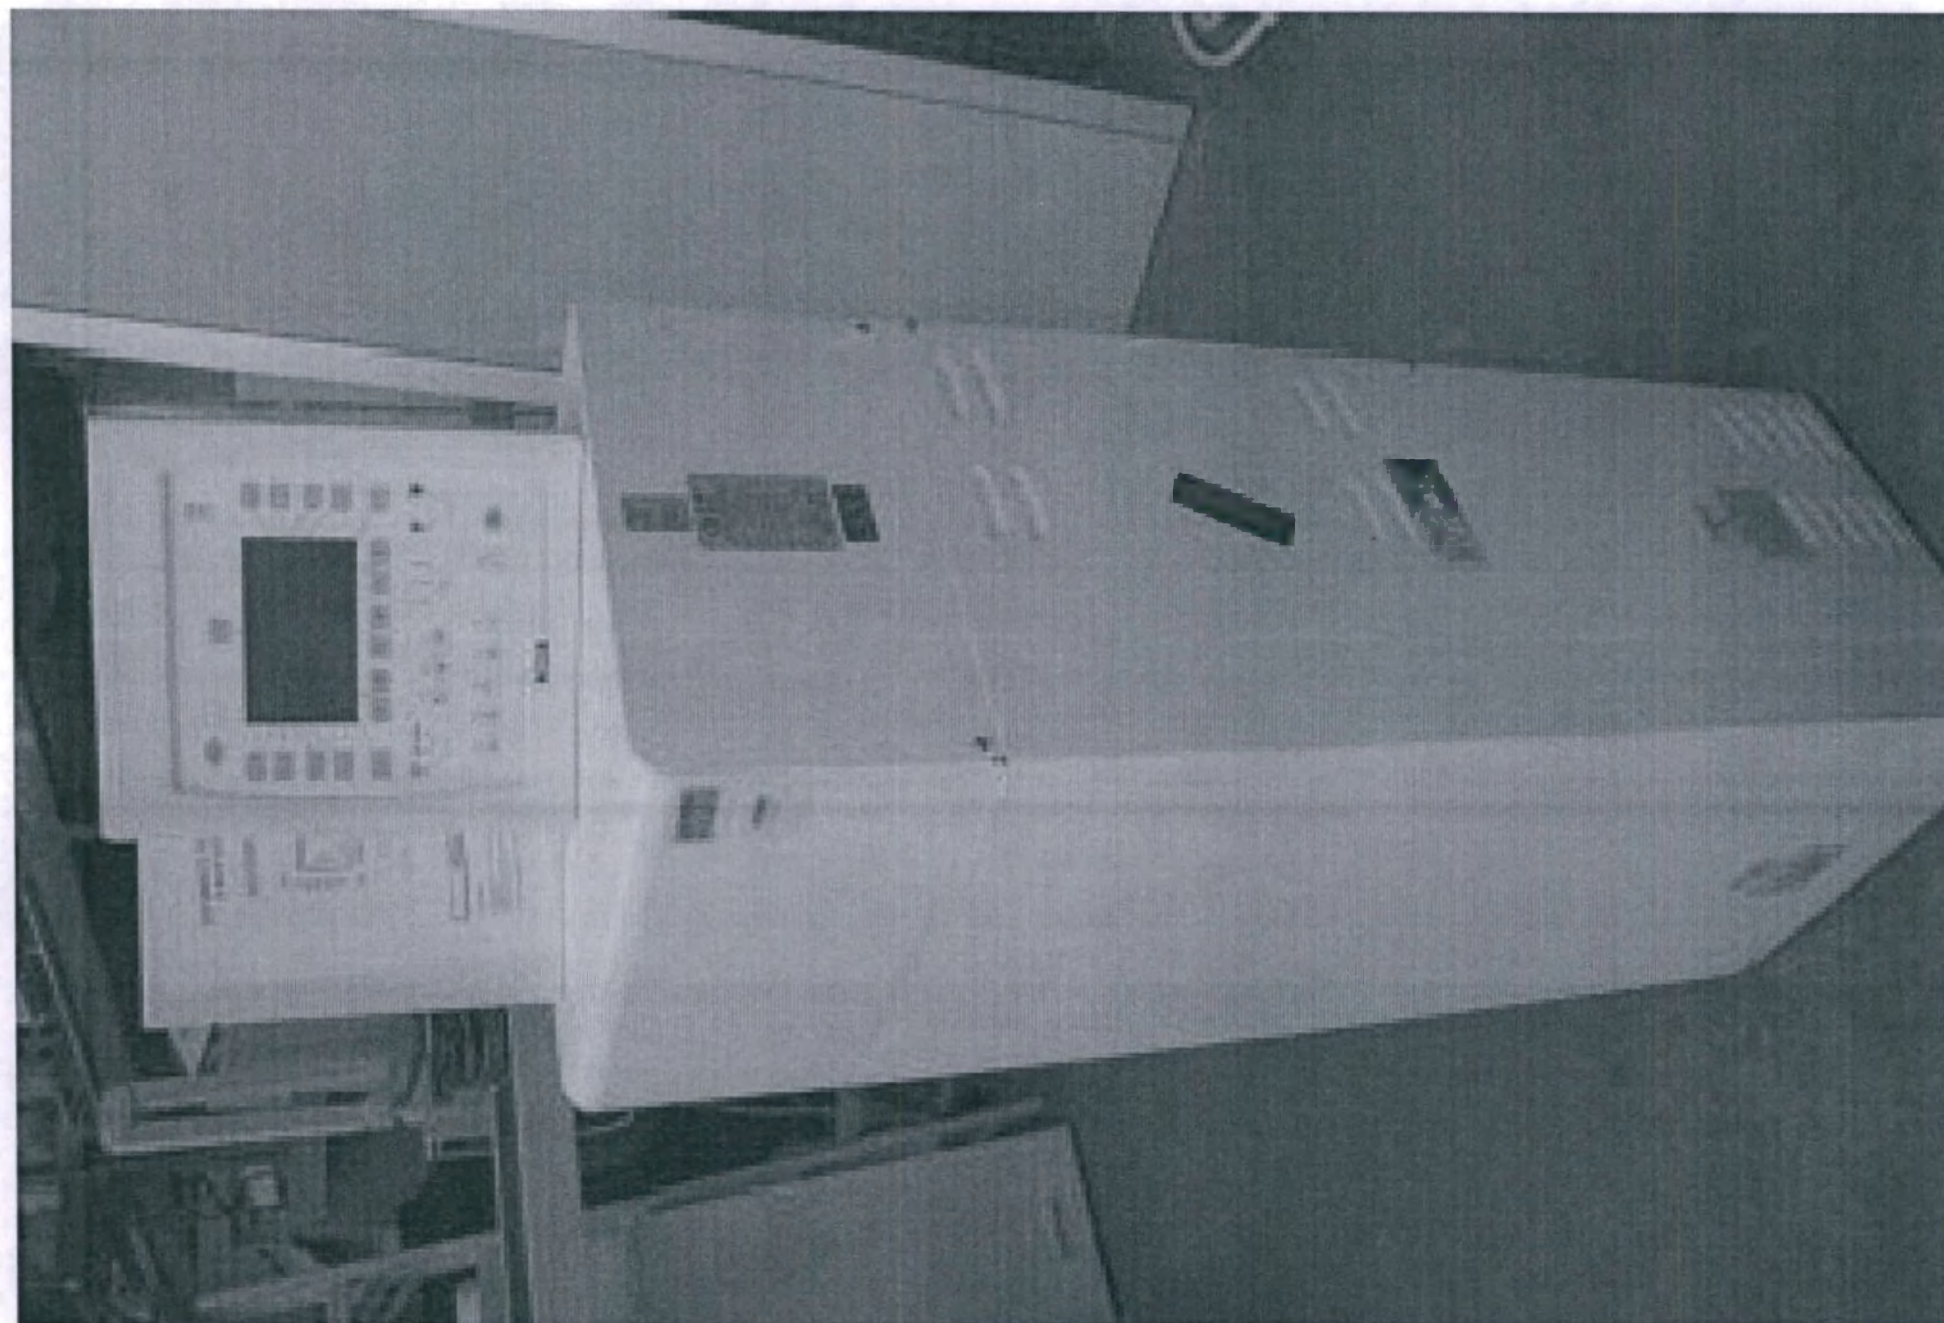


или Z, HFE производства Spellman High Voltage Electronics Corporation, США;




или Polydoros RF; Polydoros RF Rad производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

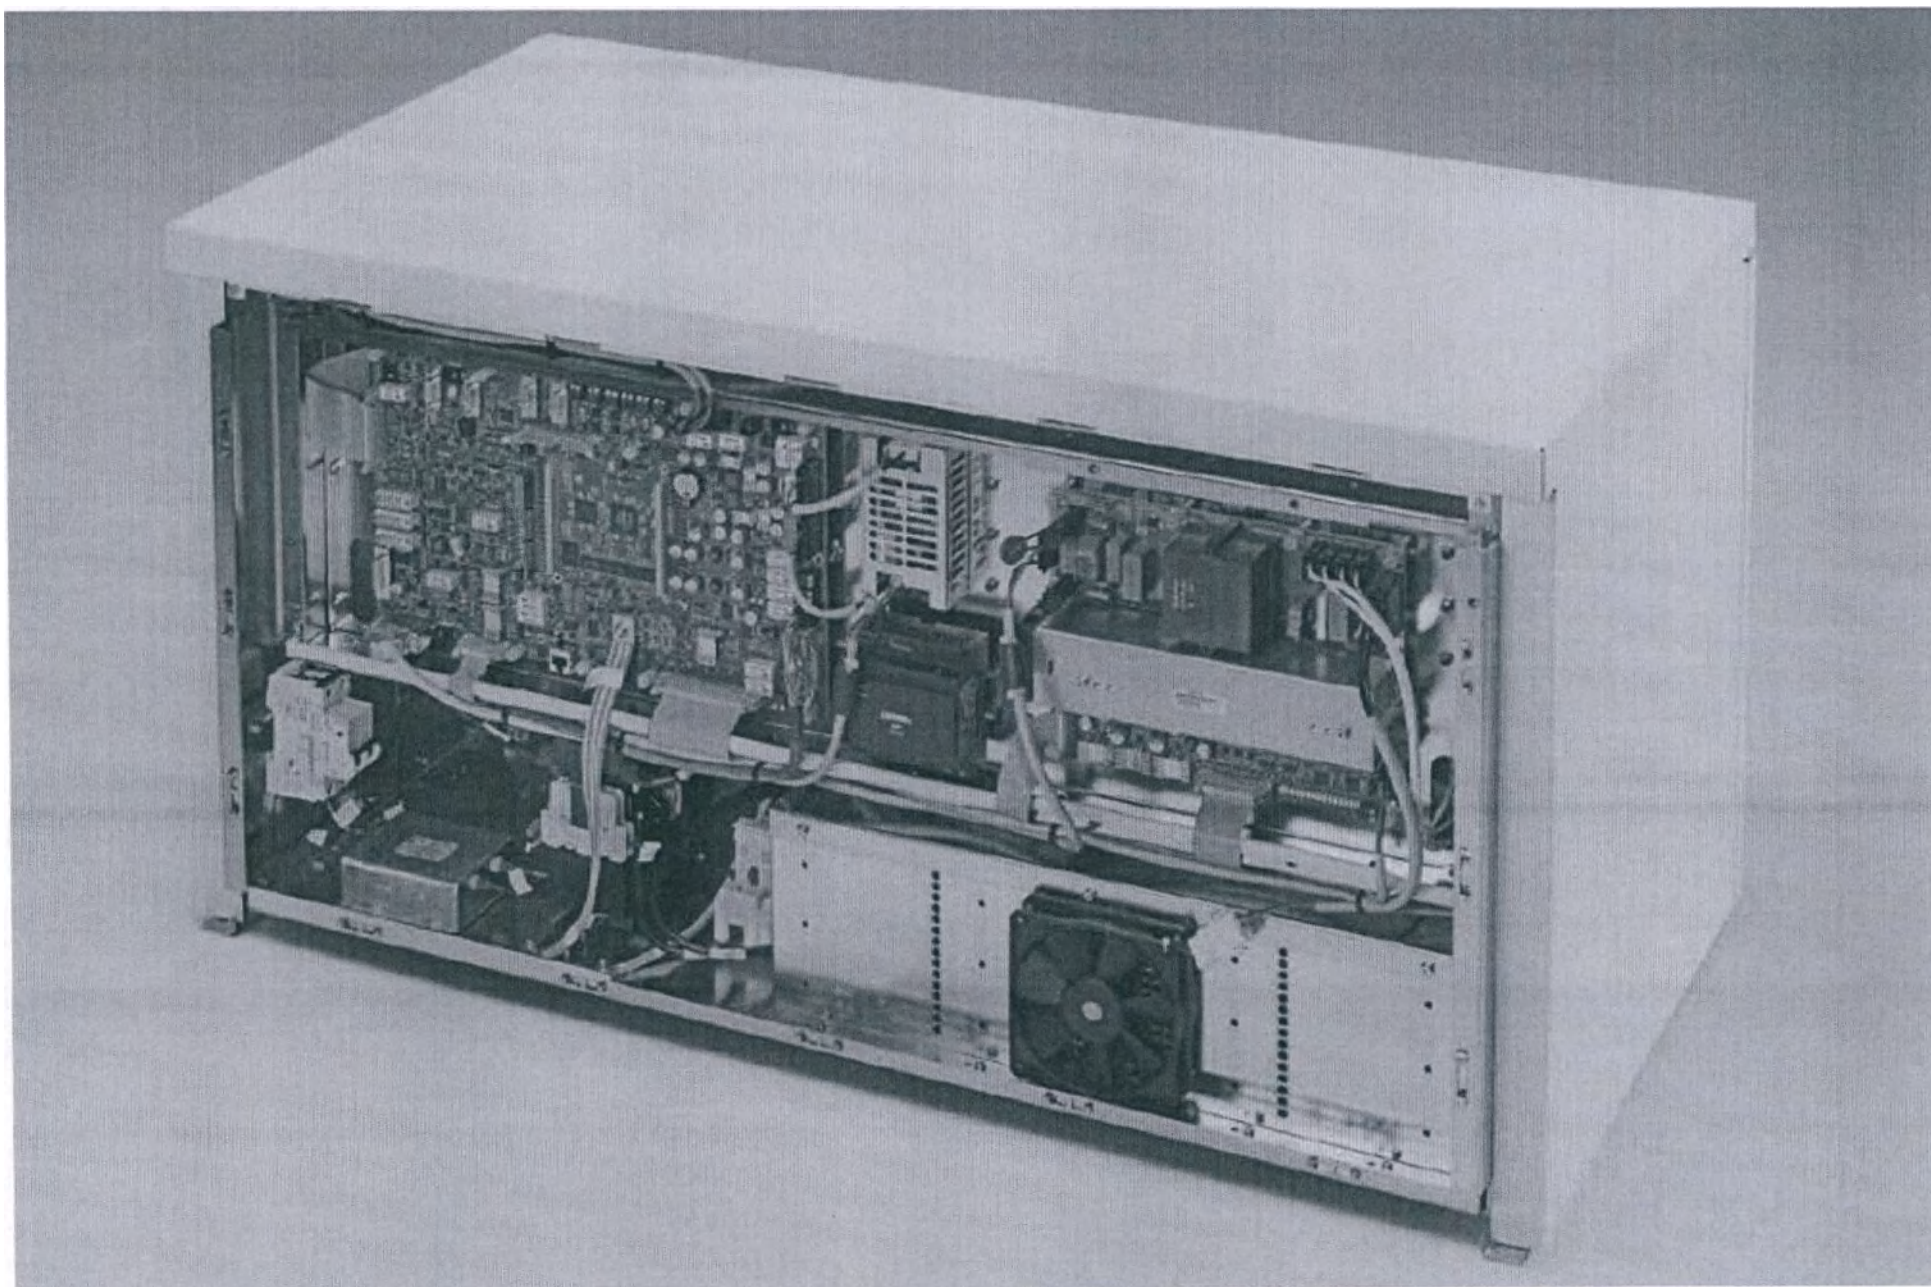



7. Стойка для рентгенографии IMX производства Imago Radiology S.r.l. Италия;

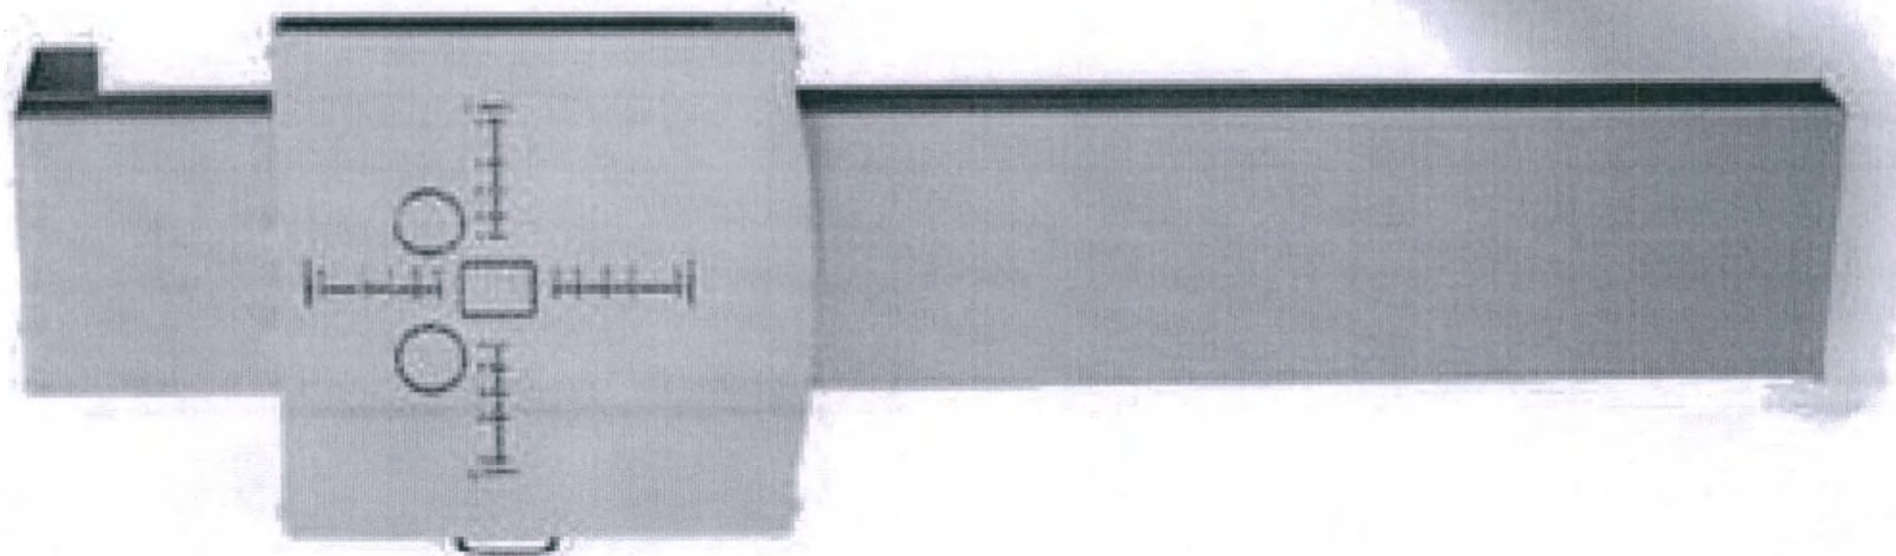


или Millenium производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания;

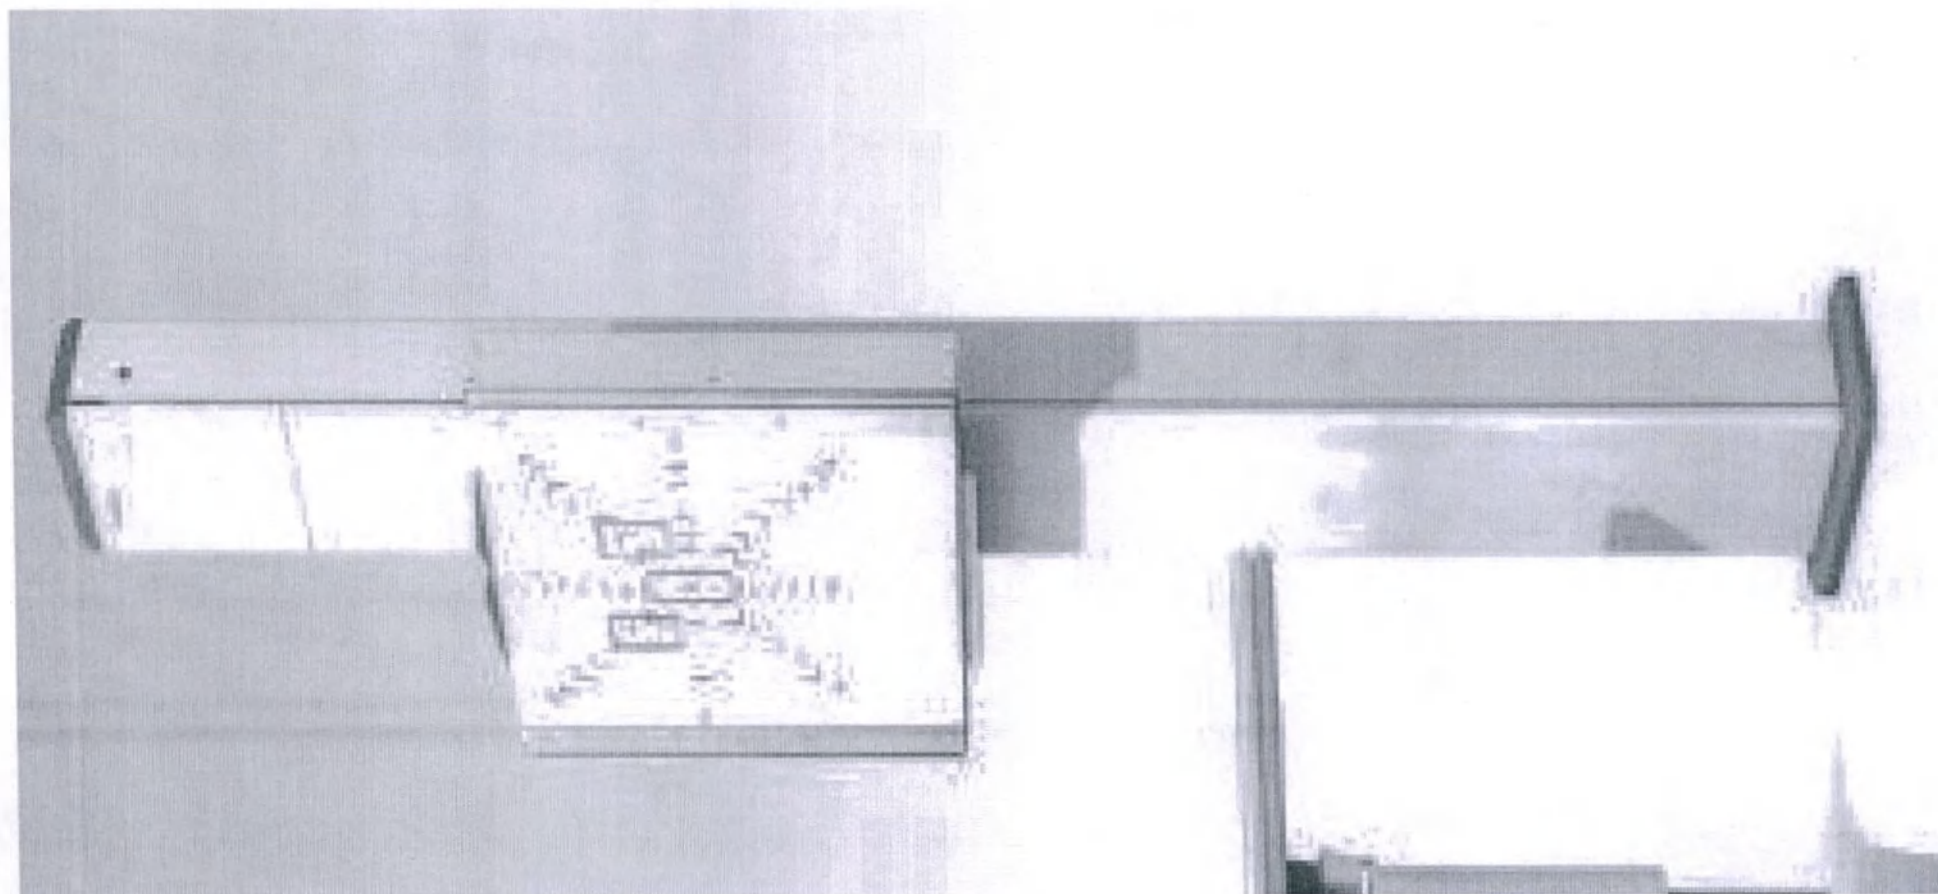


или RS производства General Medical Merate SPA (GMM) Италия;

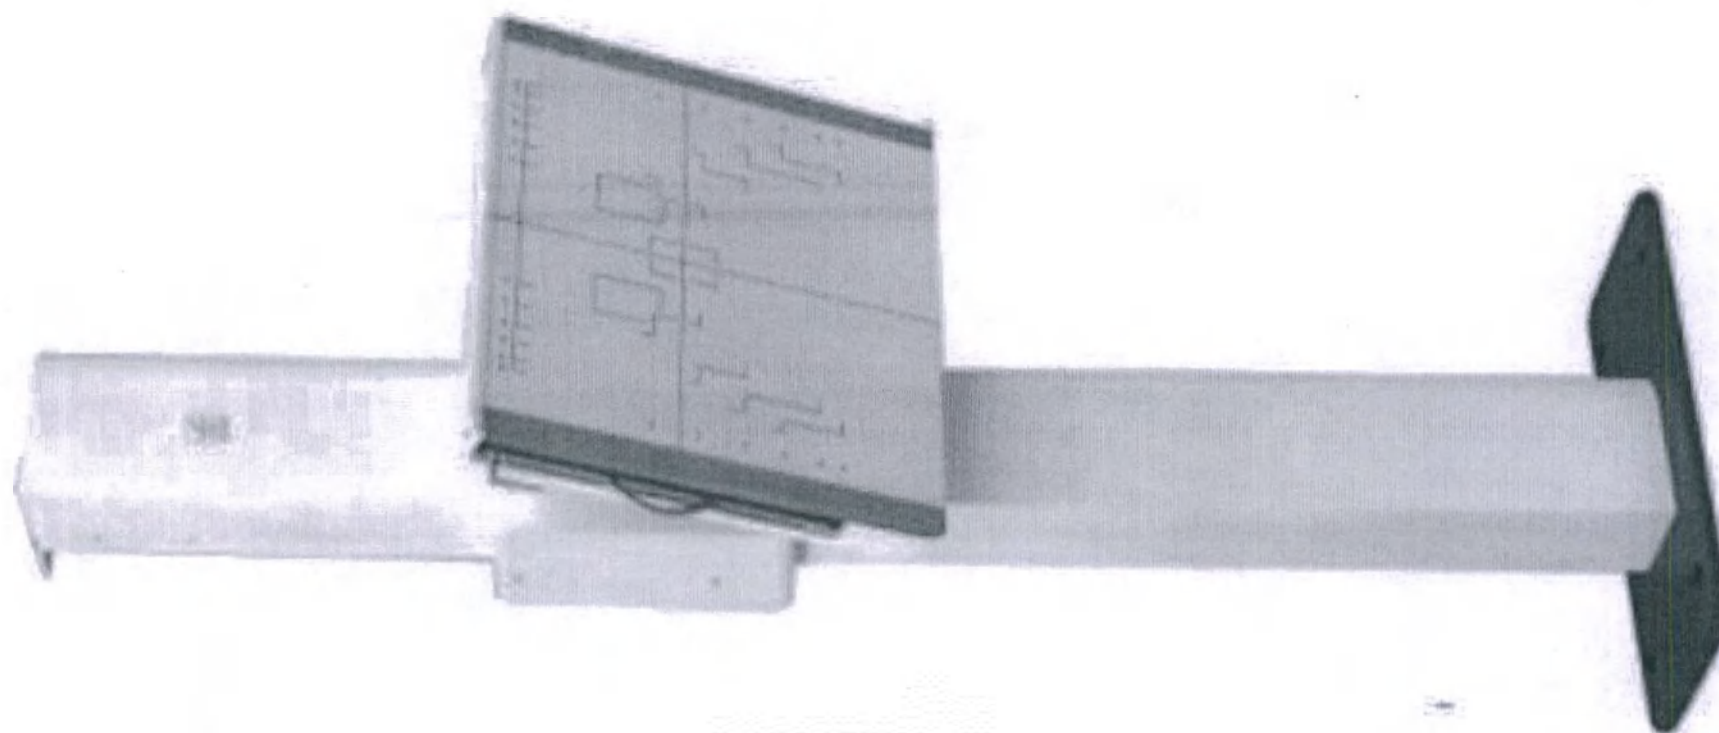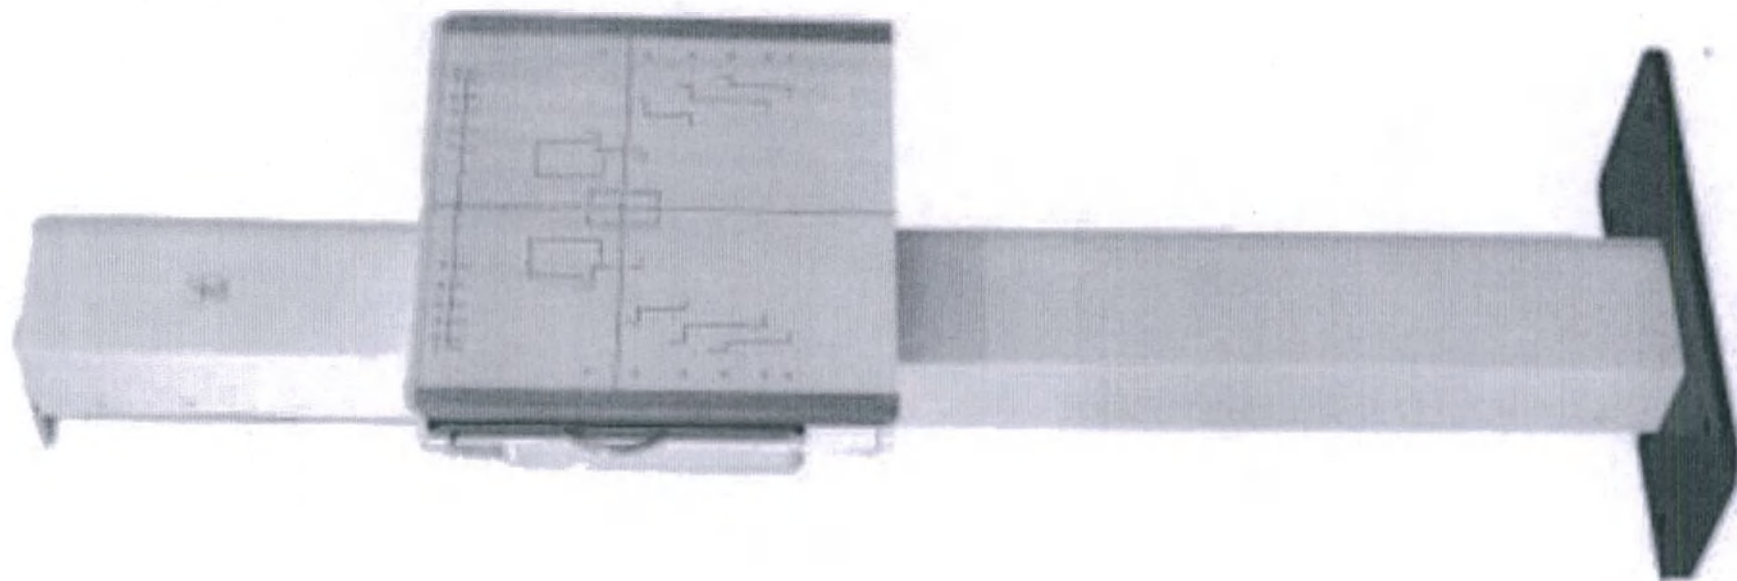


или АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

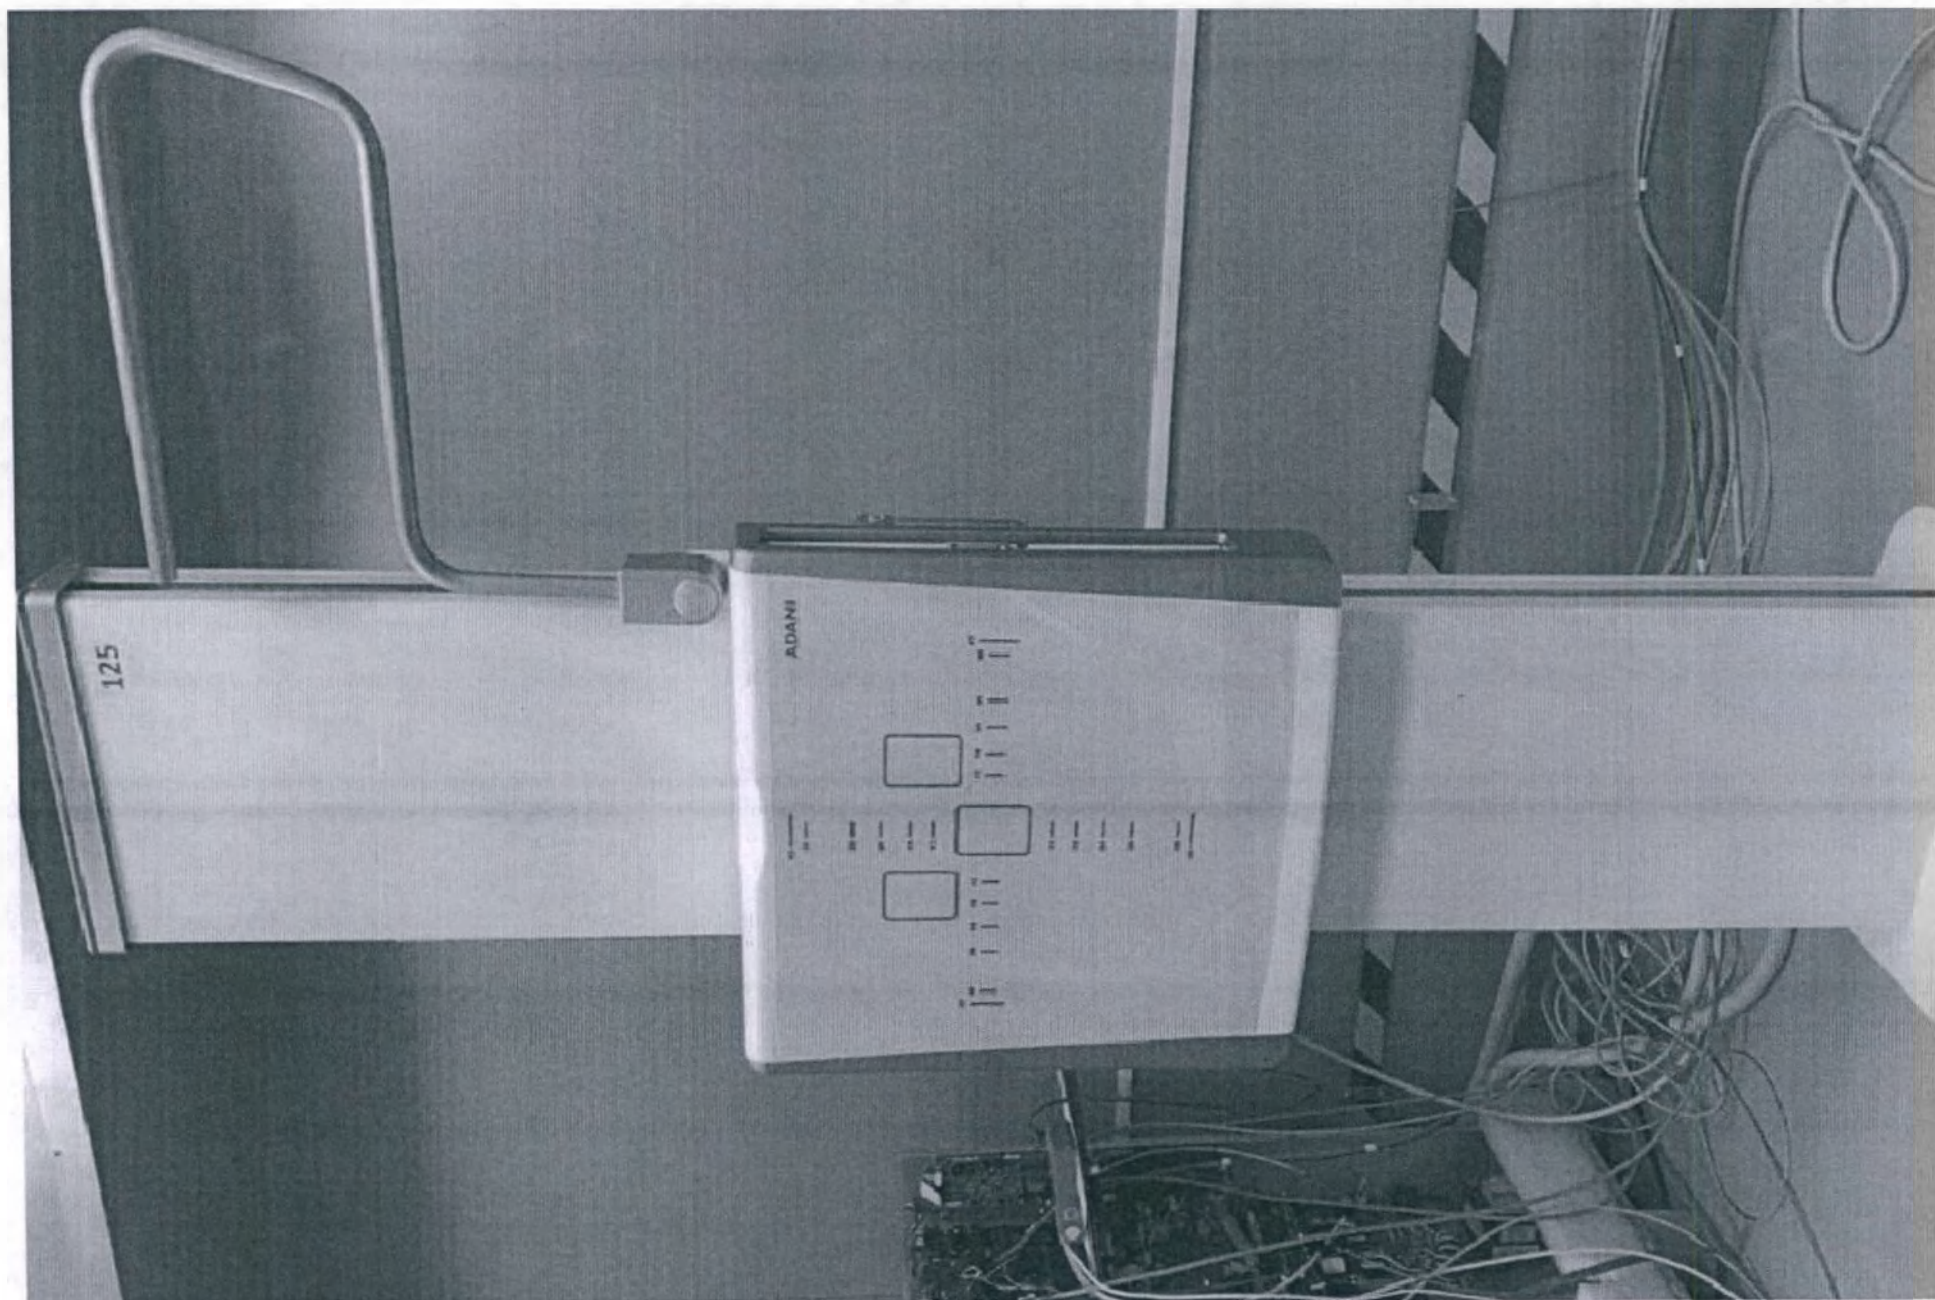

или производства Diagnostic Medical System Apelem, Франция;

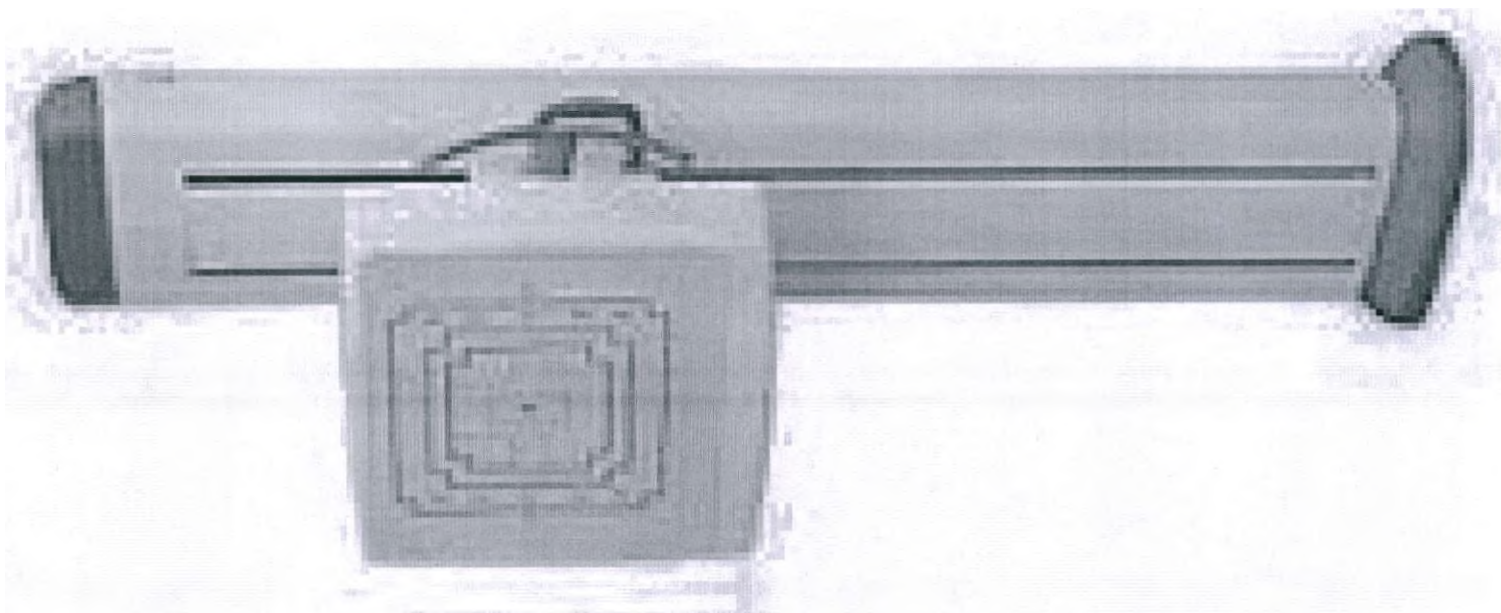


или WS производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

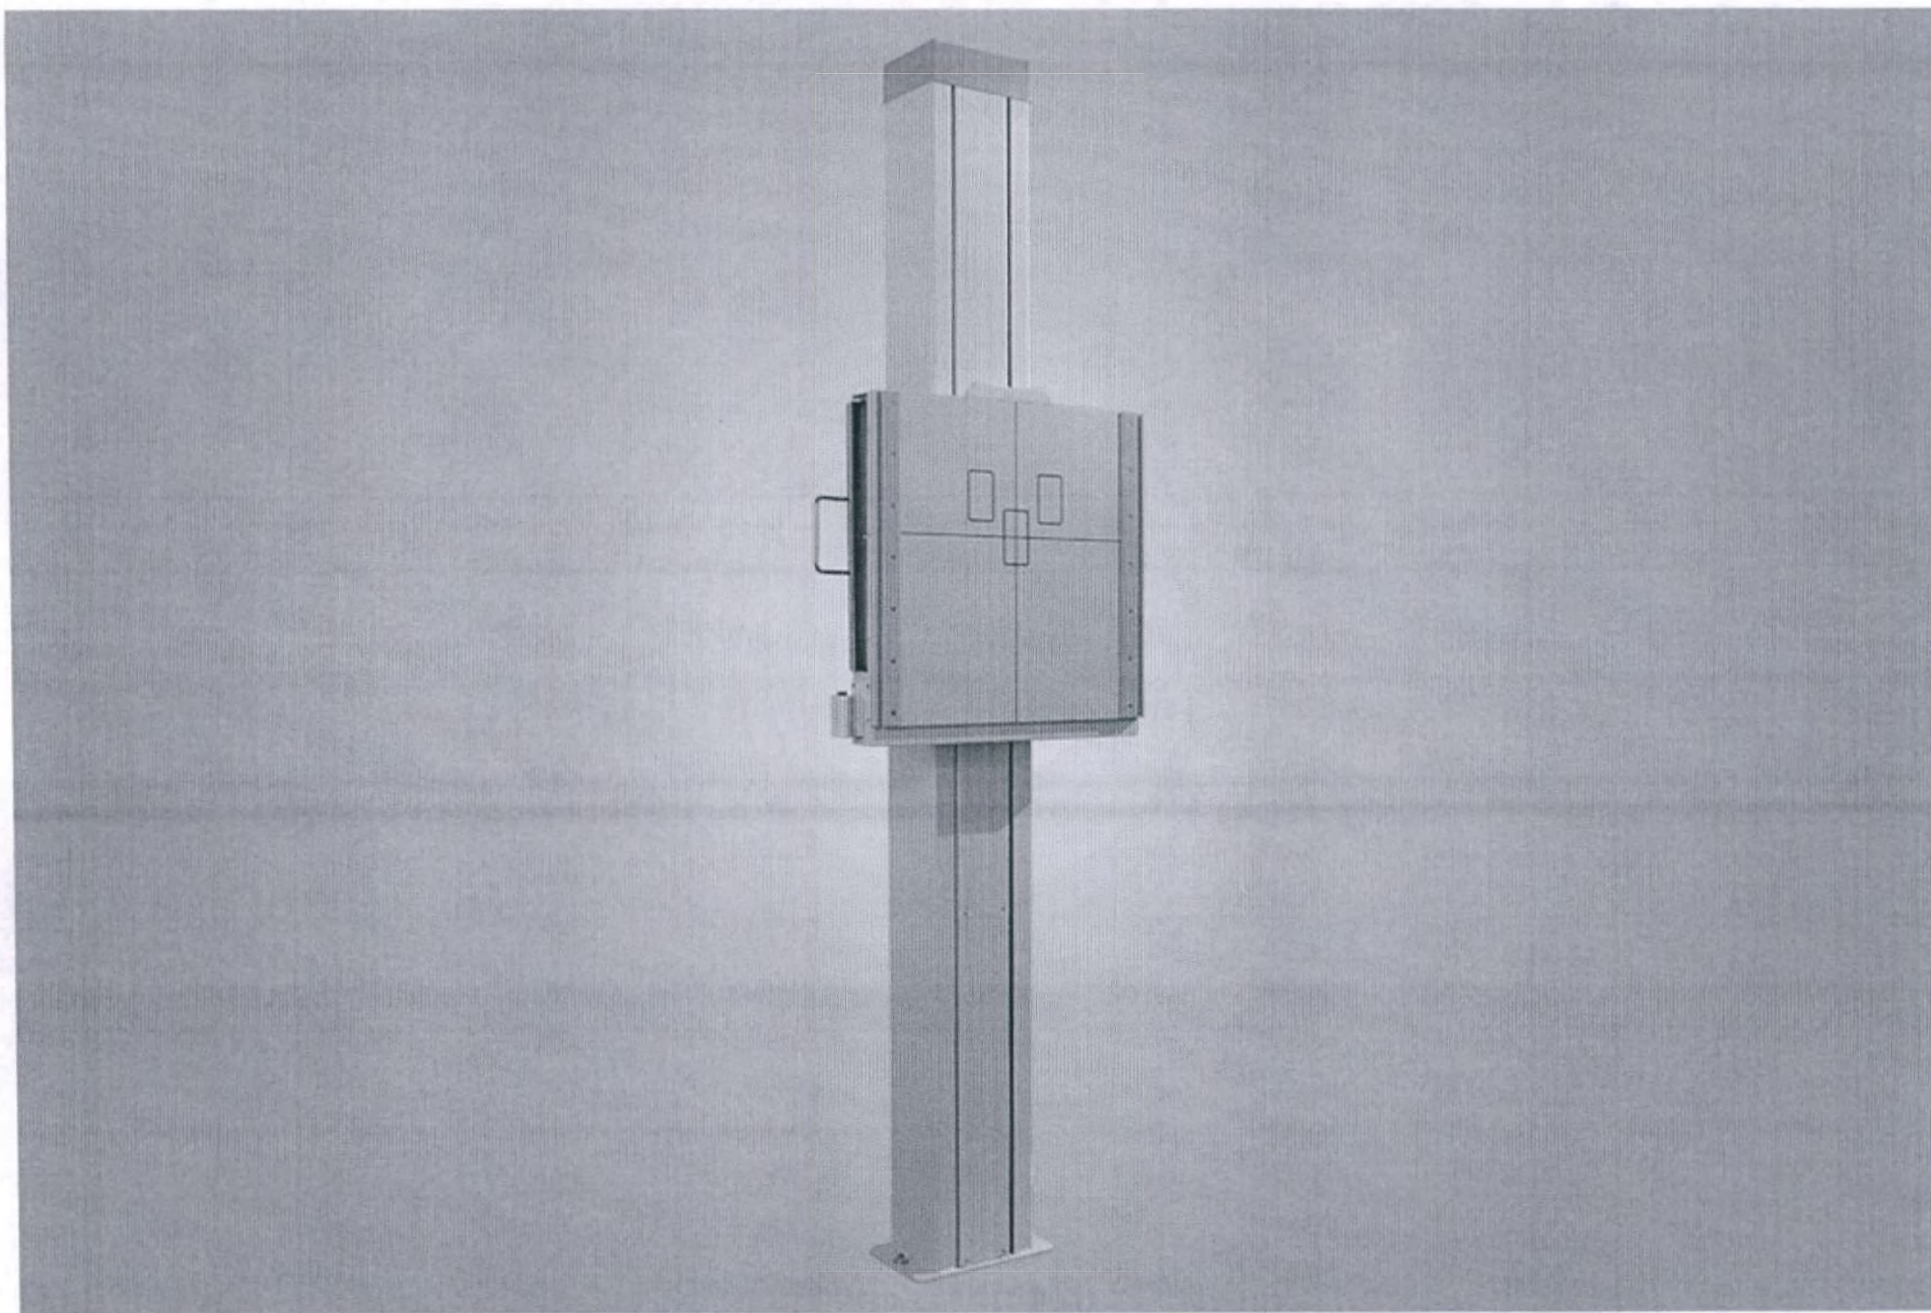


8. Комплект эксплуатационной документации.


9. Анти-рассеивающая решетка производства JPI Healthcare Co, Ltd, Республика Корея;

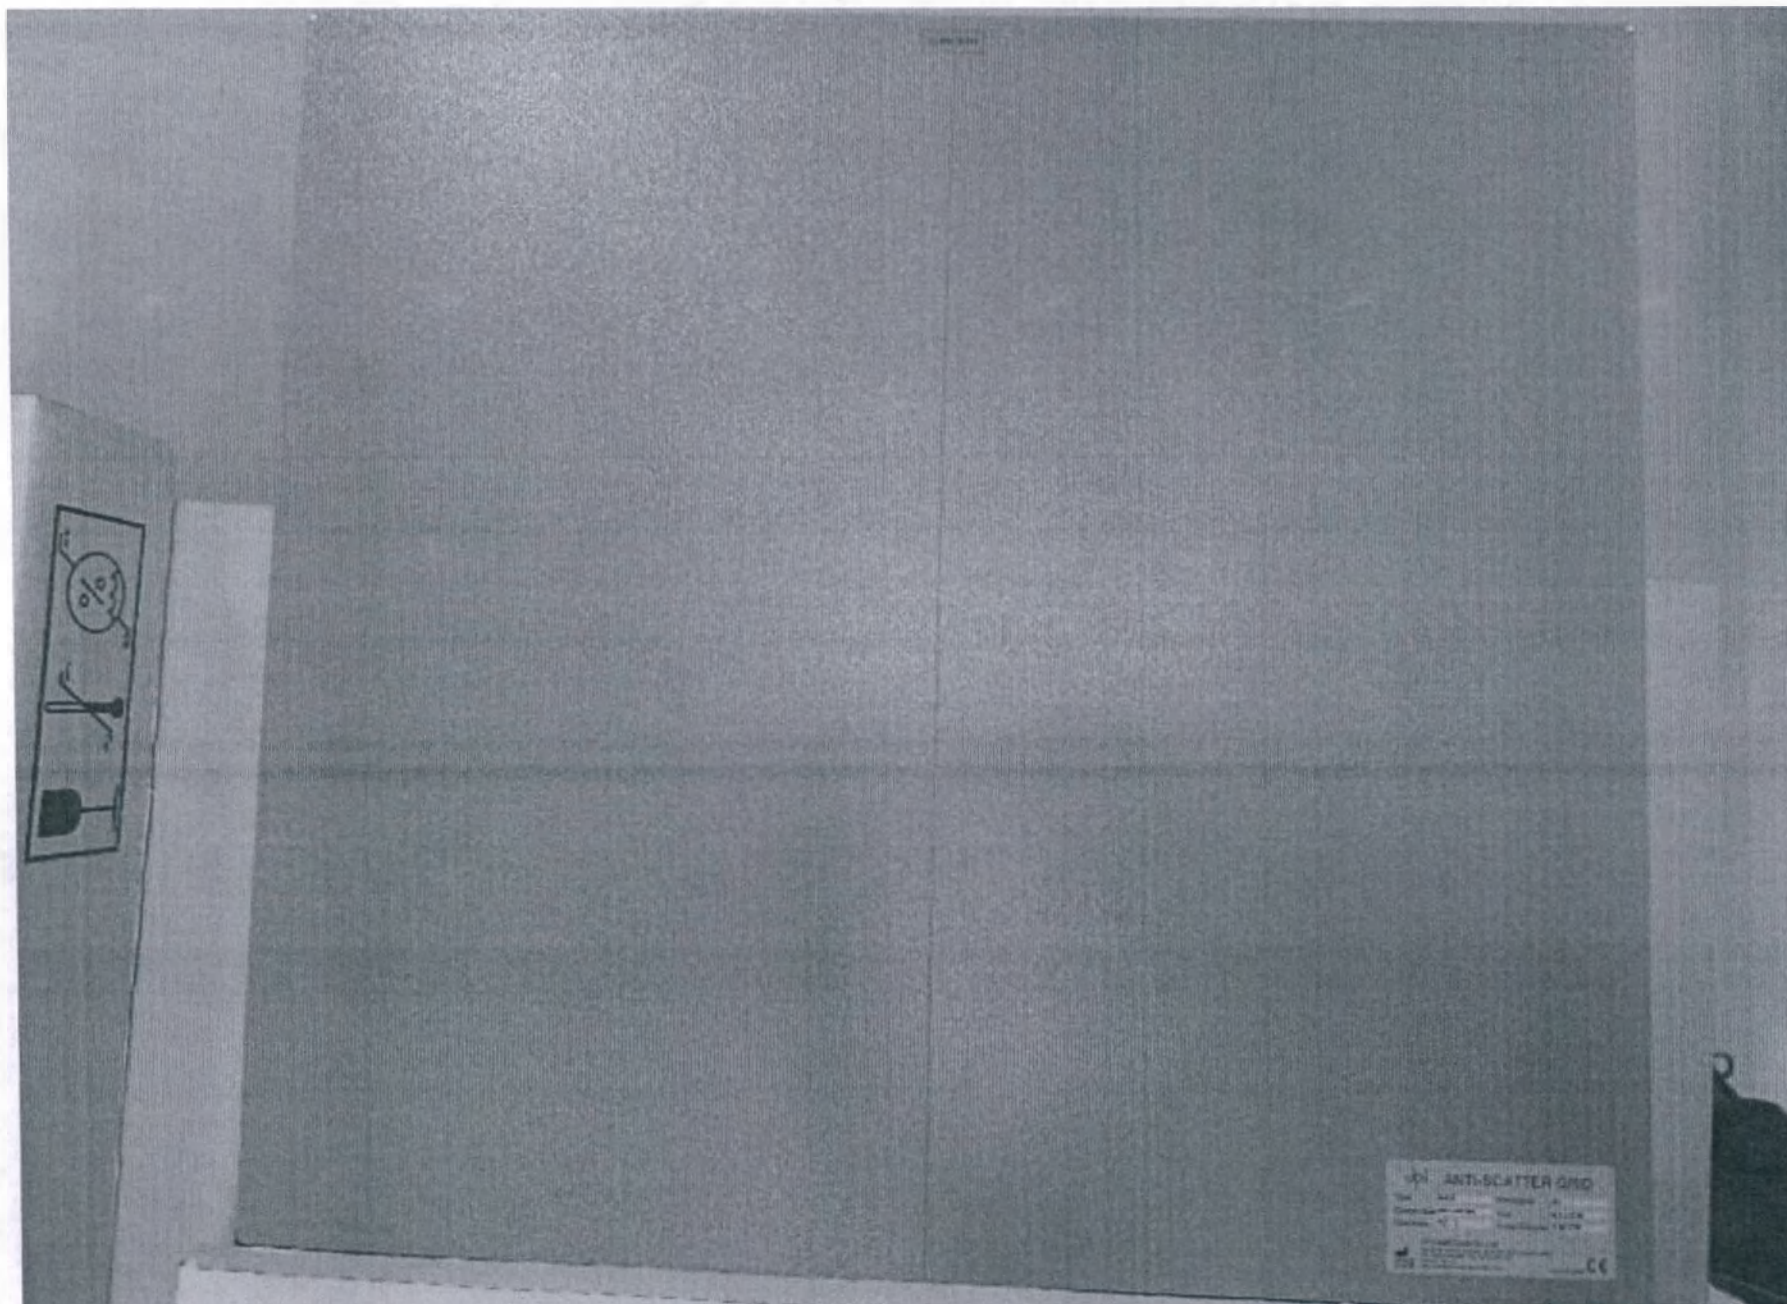


или производства Gilardoni S.p.A, Италия;

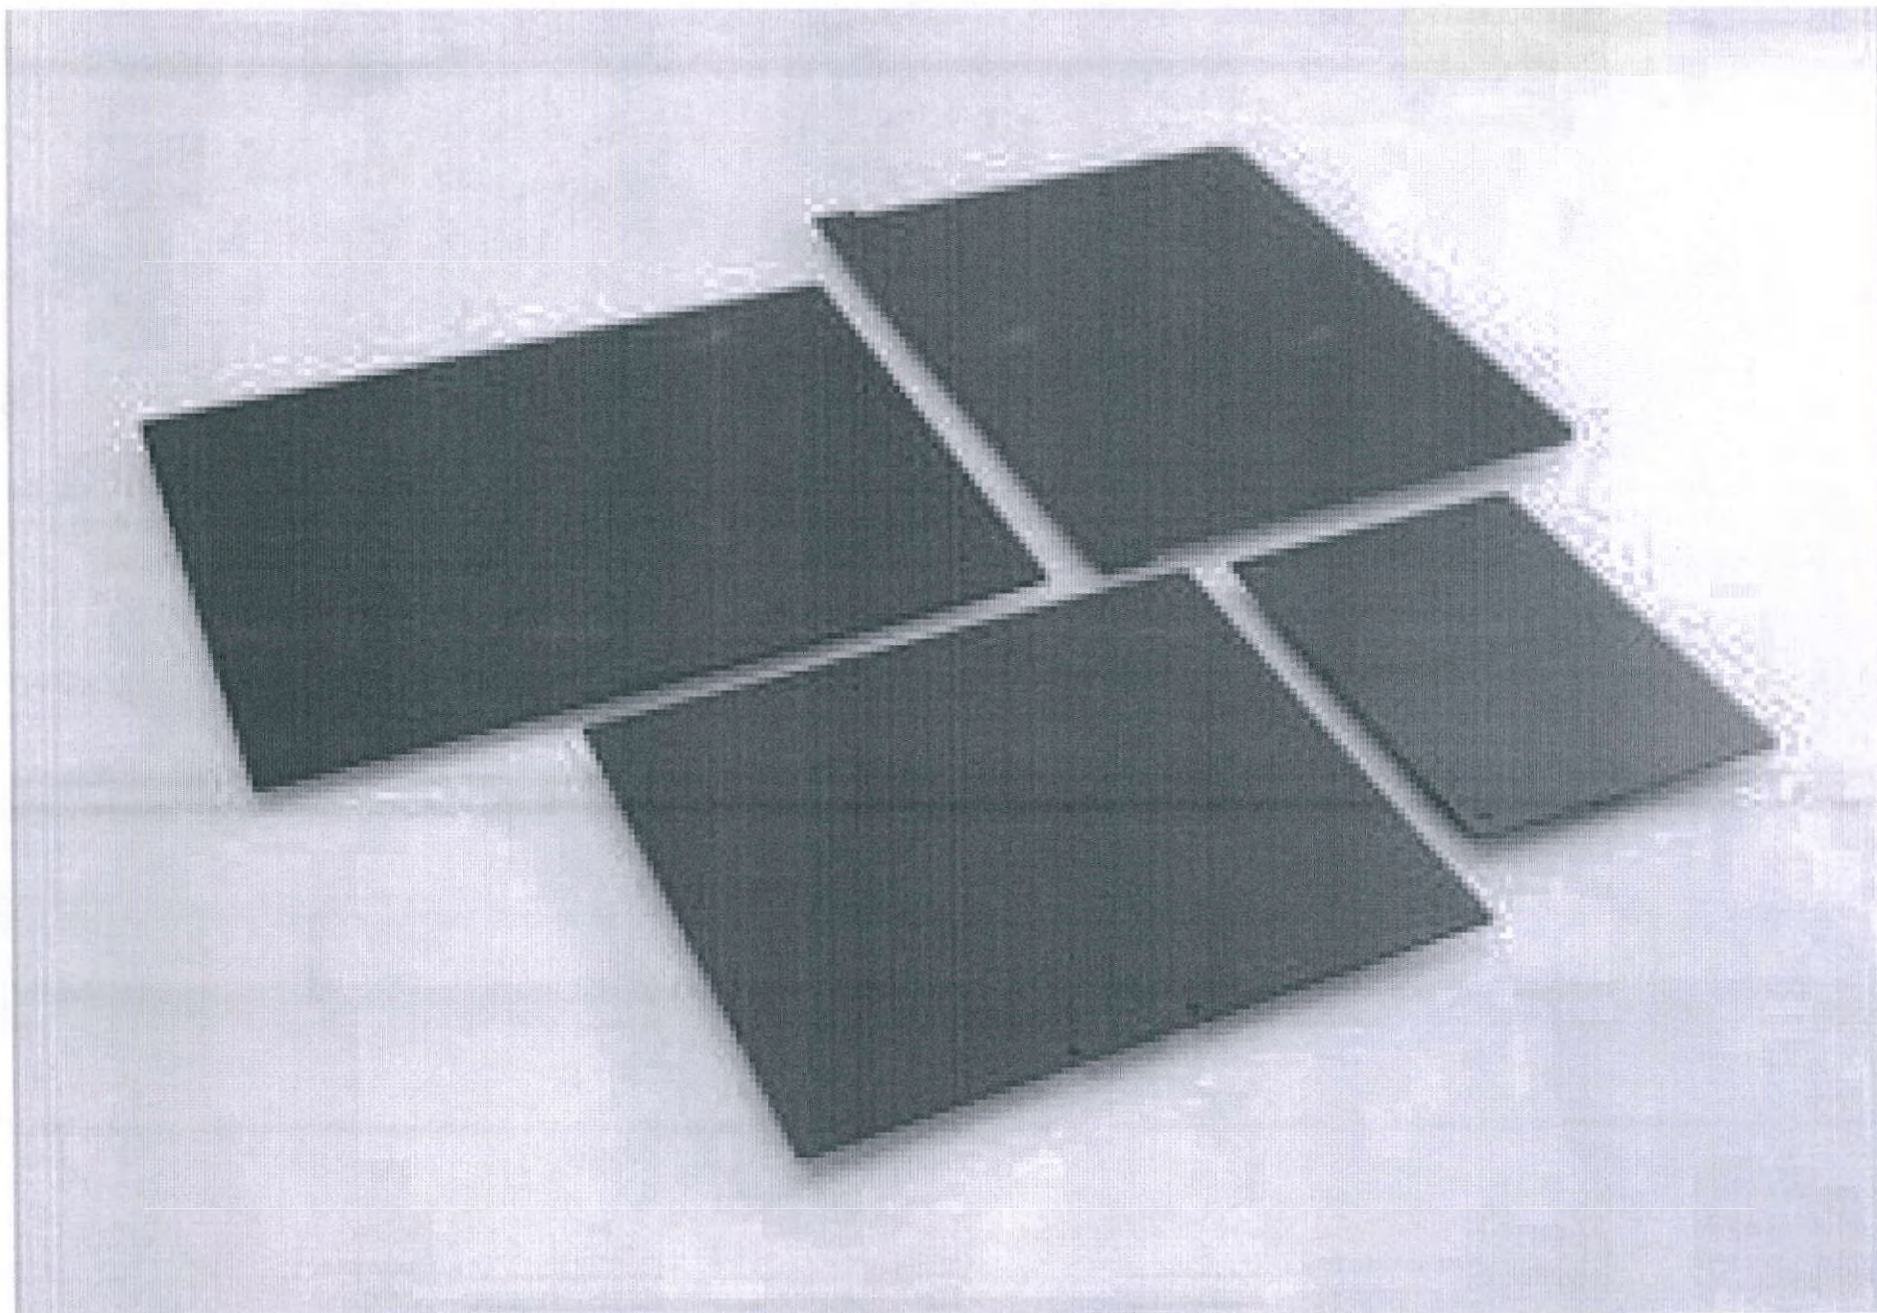


или Ysio производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

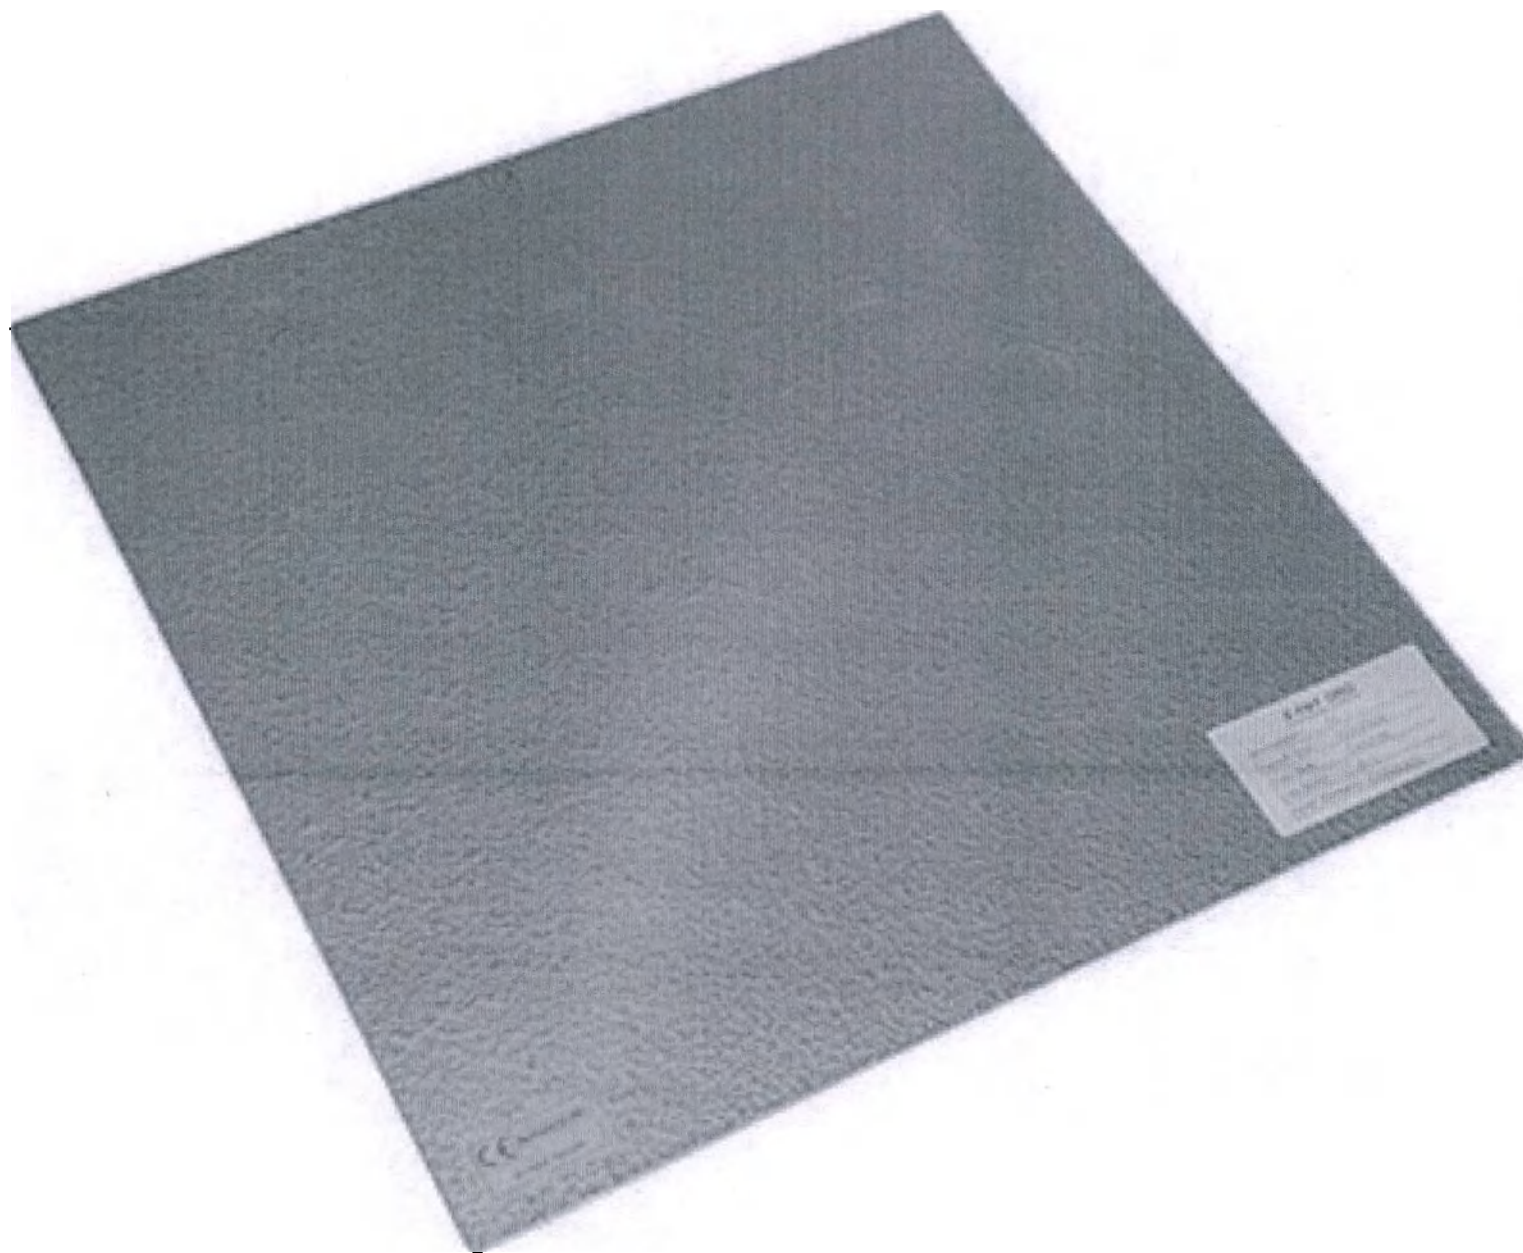


10. Камера ионизационная производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия;

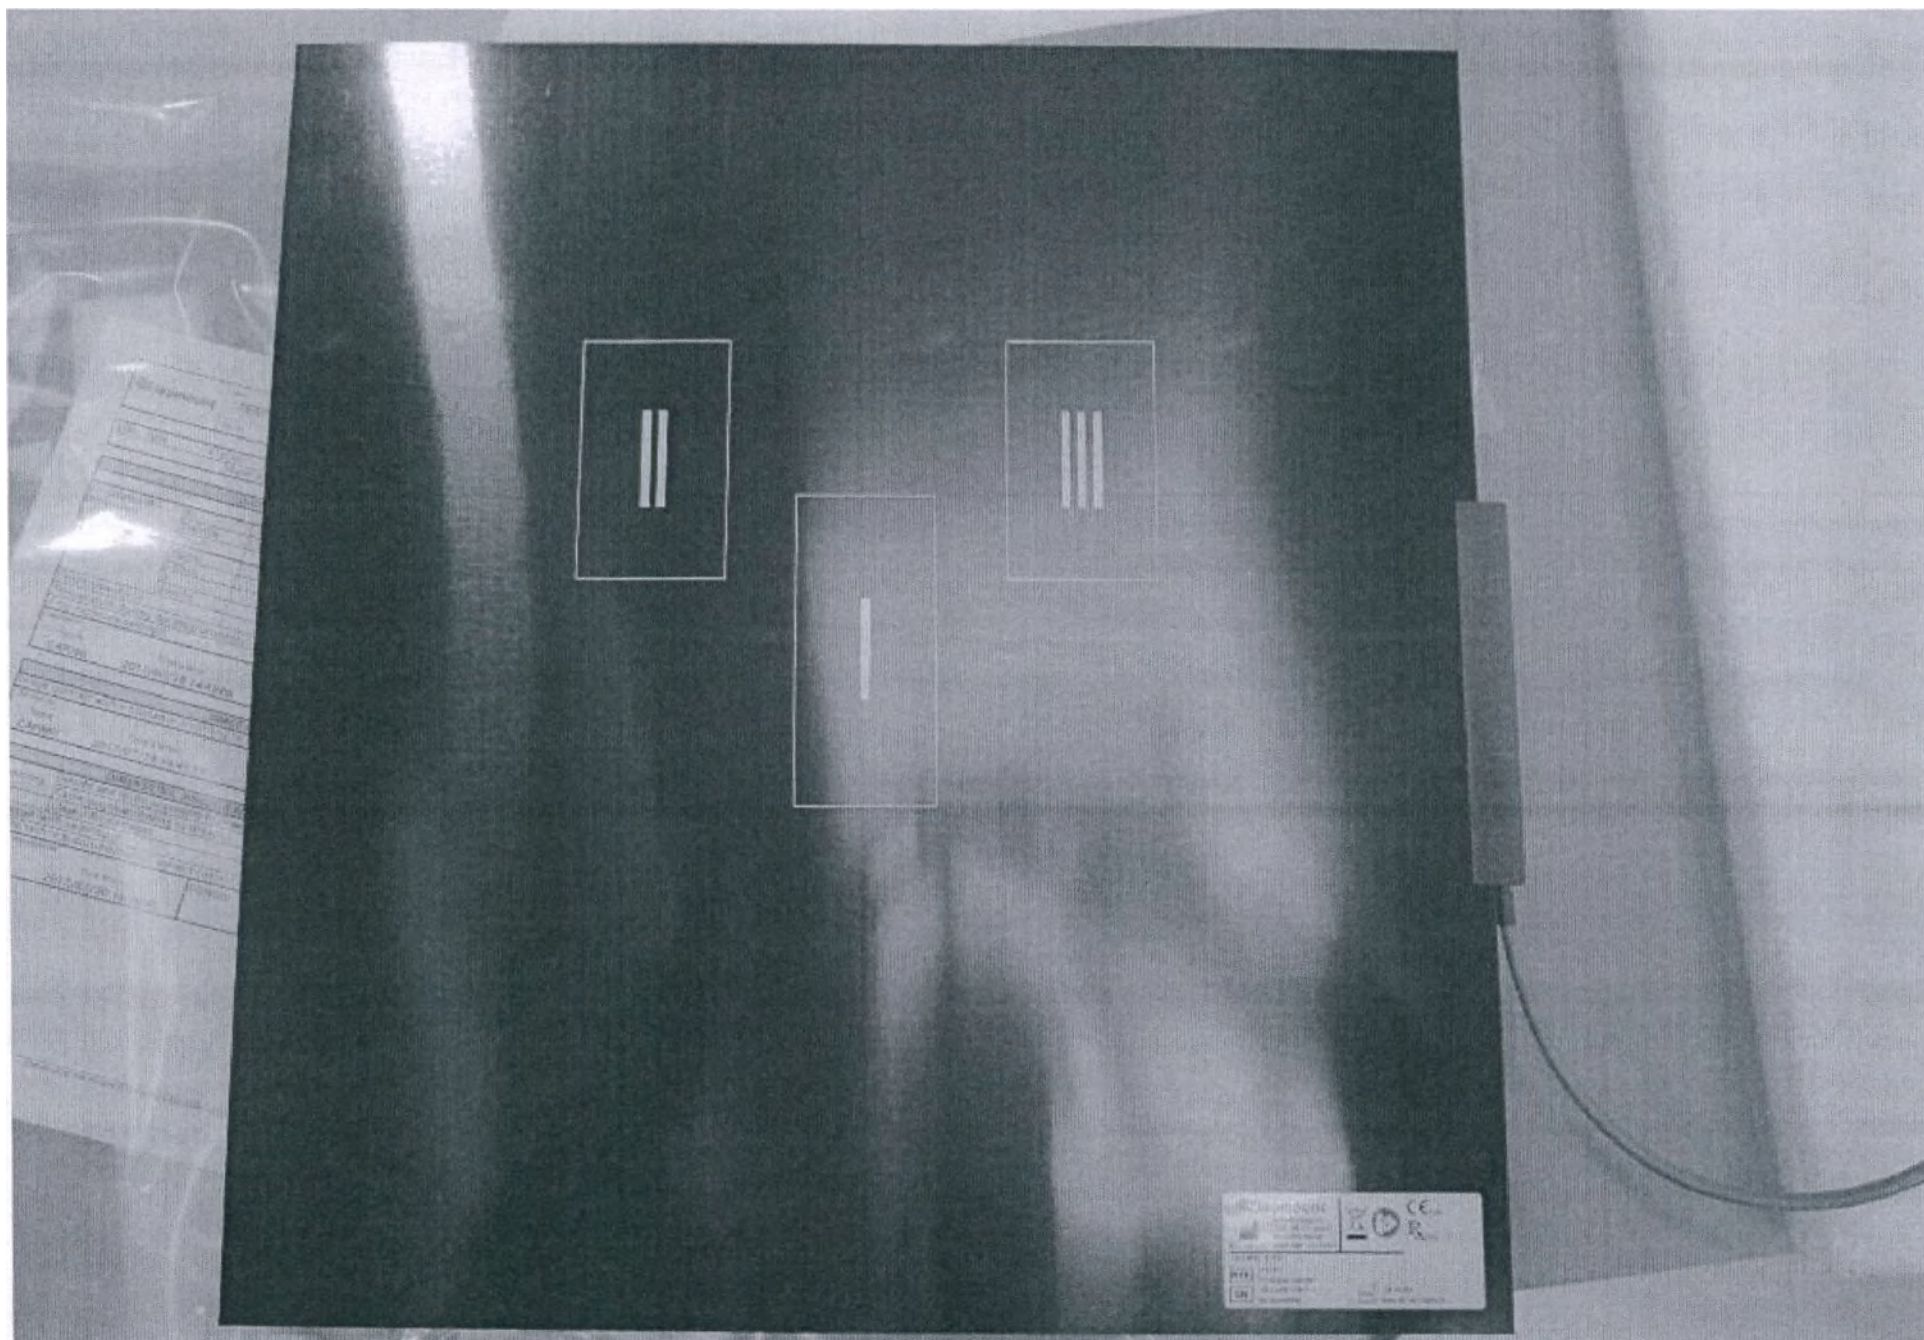


или SSMC; ICX В производства Varex Imaging Corporation, США;

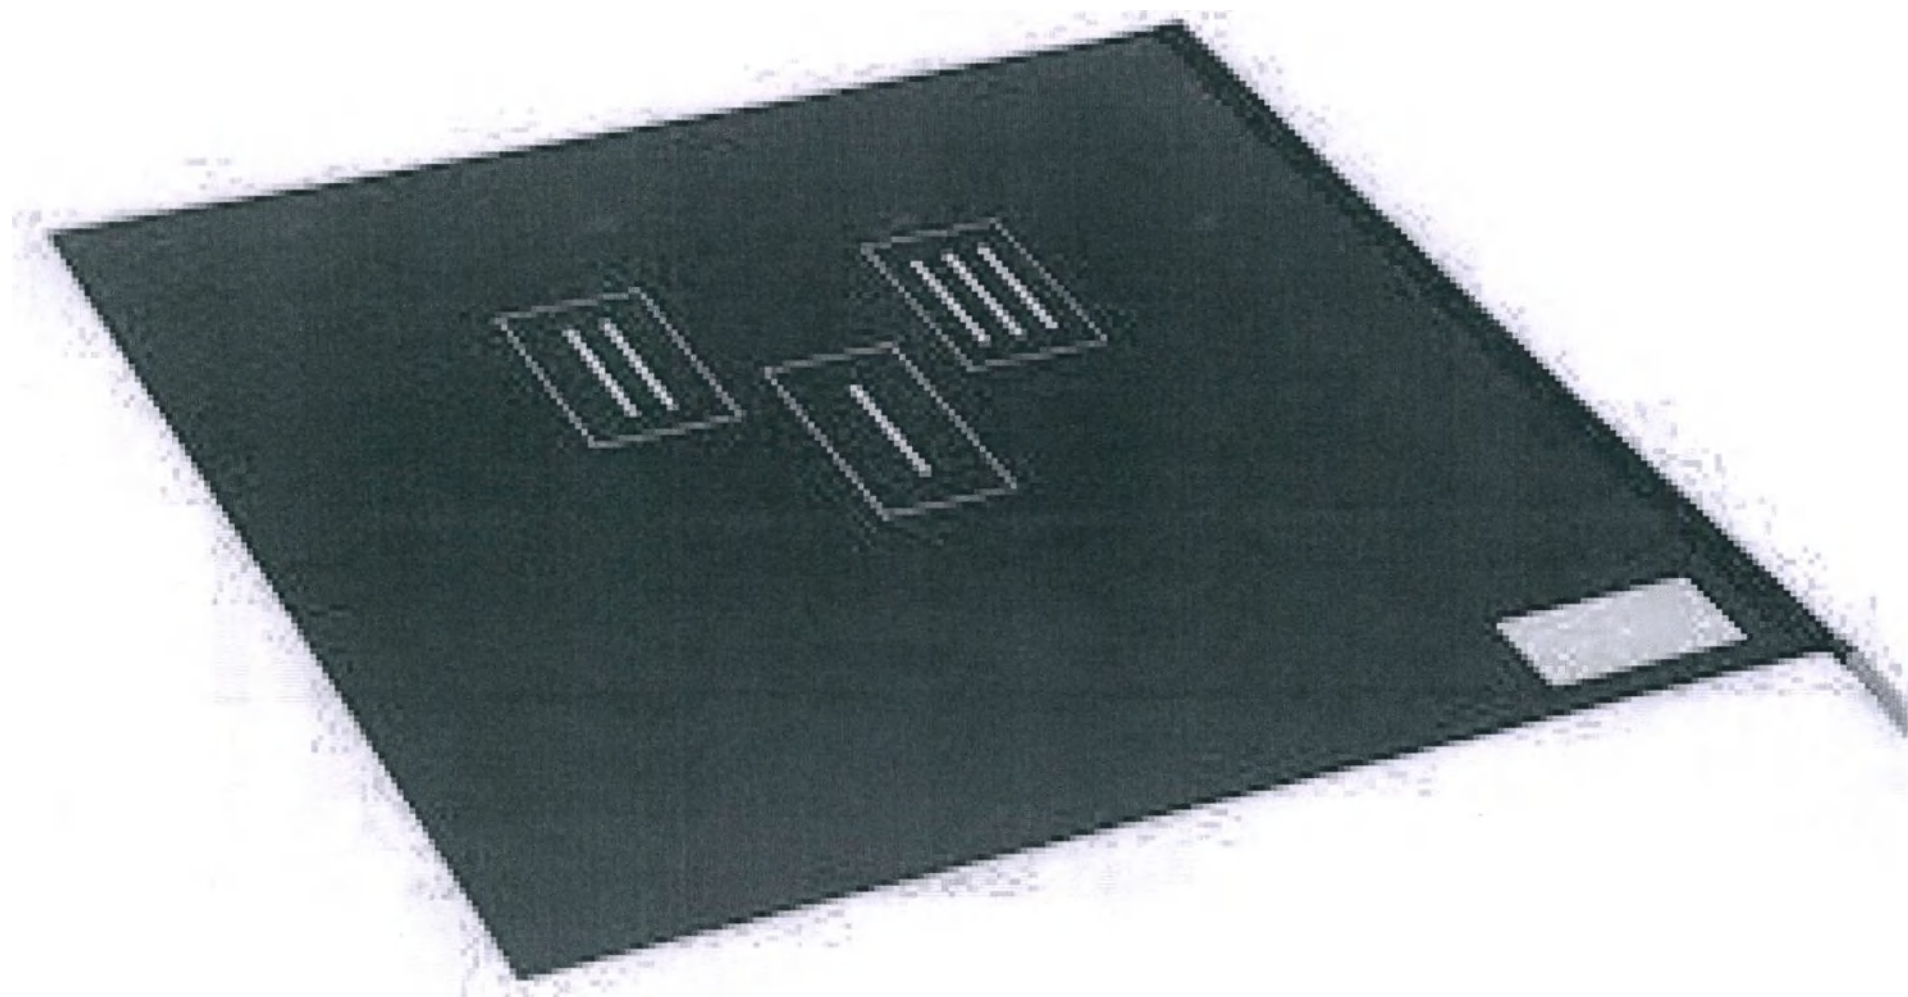


или XT; 5FA; 3FA производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

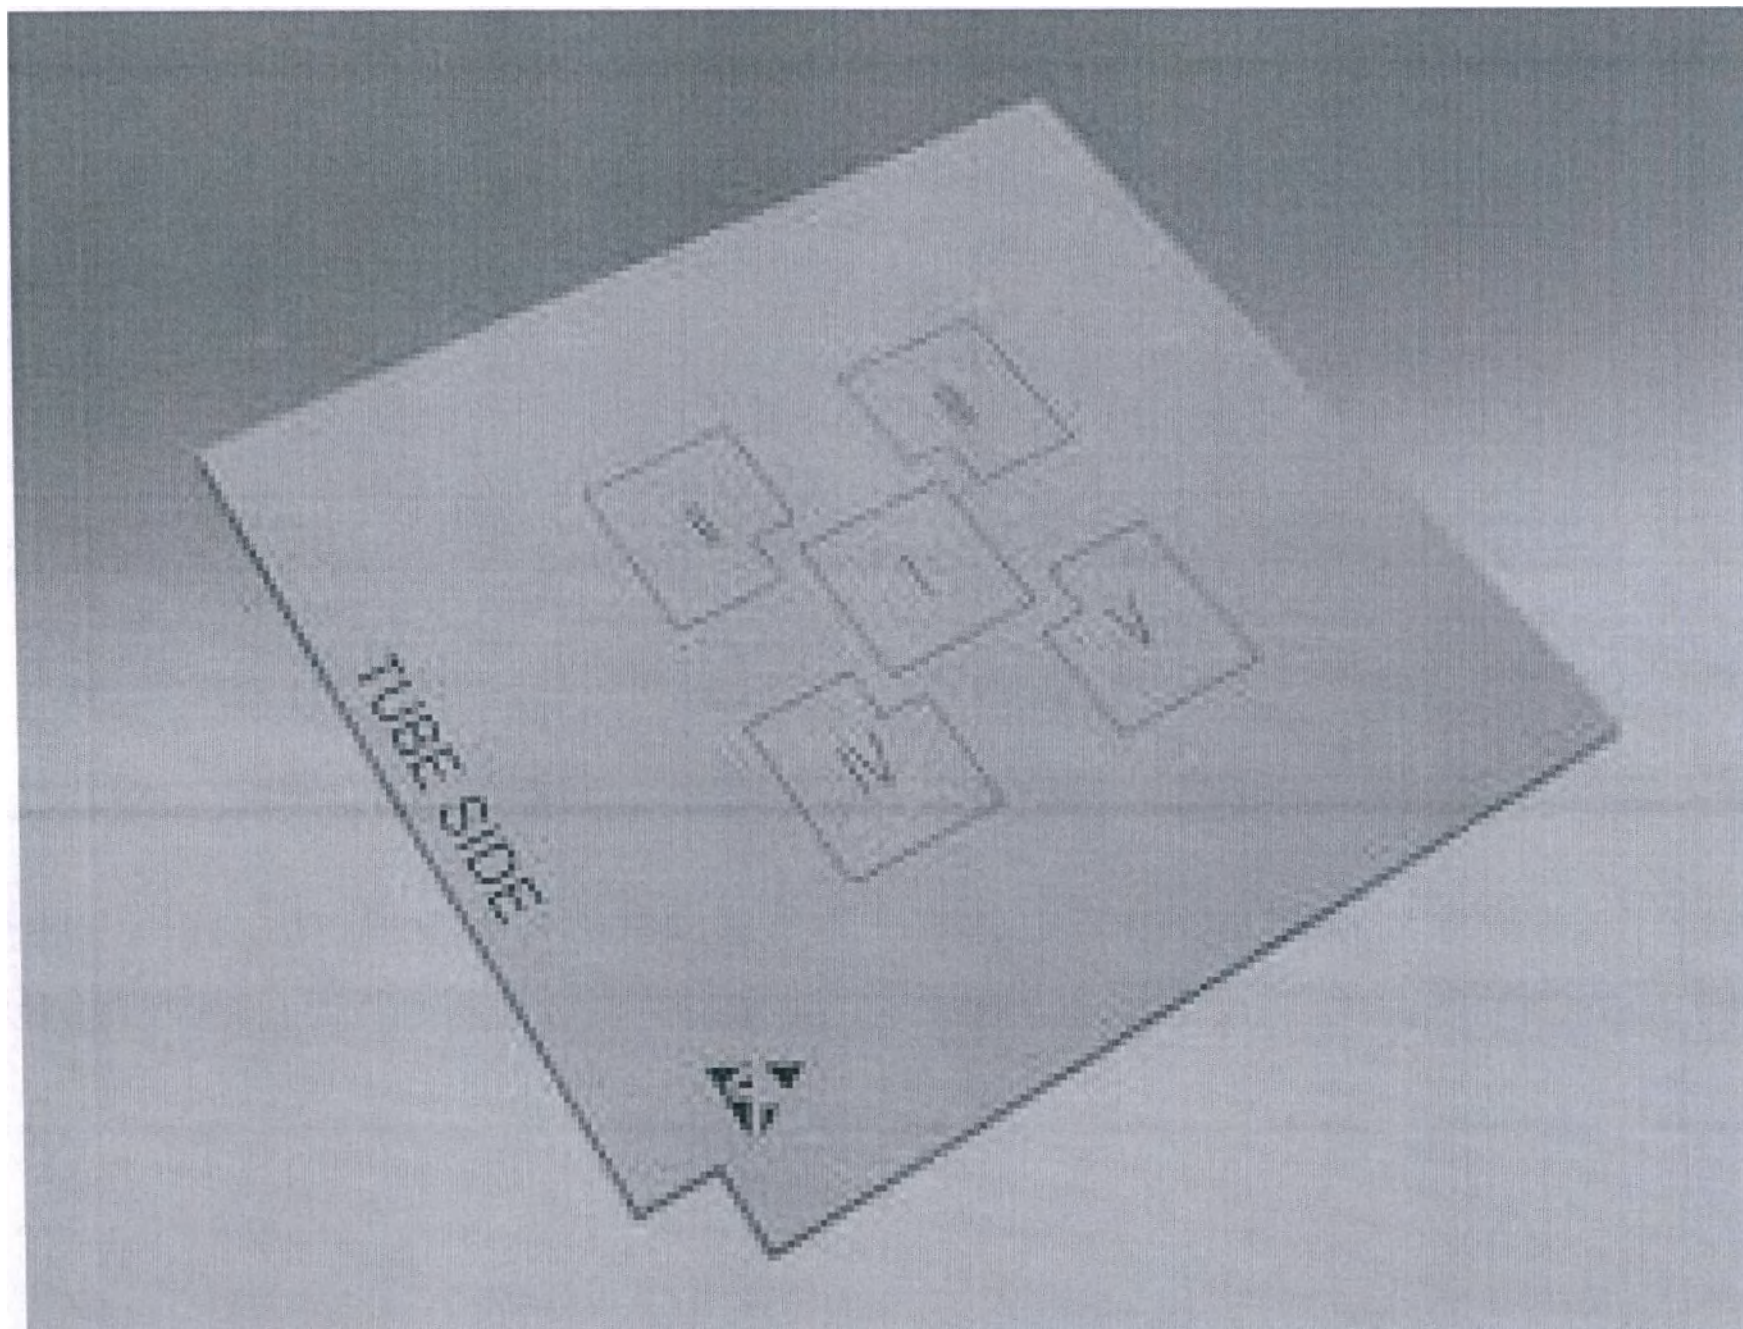

11. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 производства ООО НПП «Доза», Российская Федерация (РУ № РЗН 2014/1562);

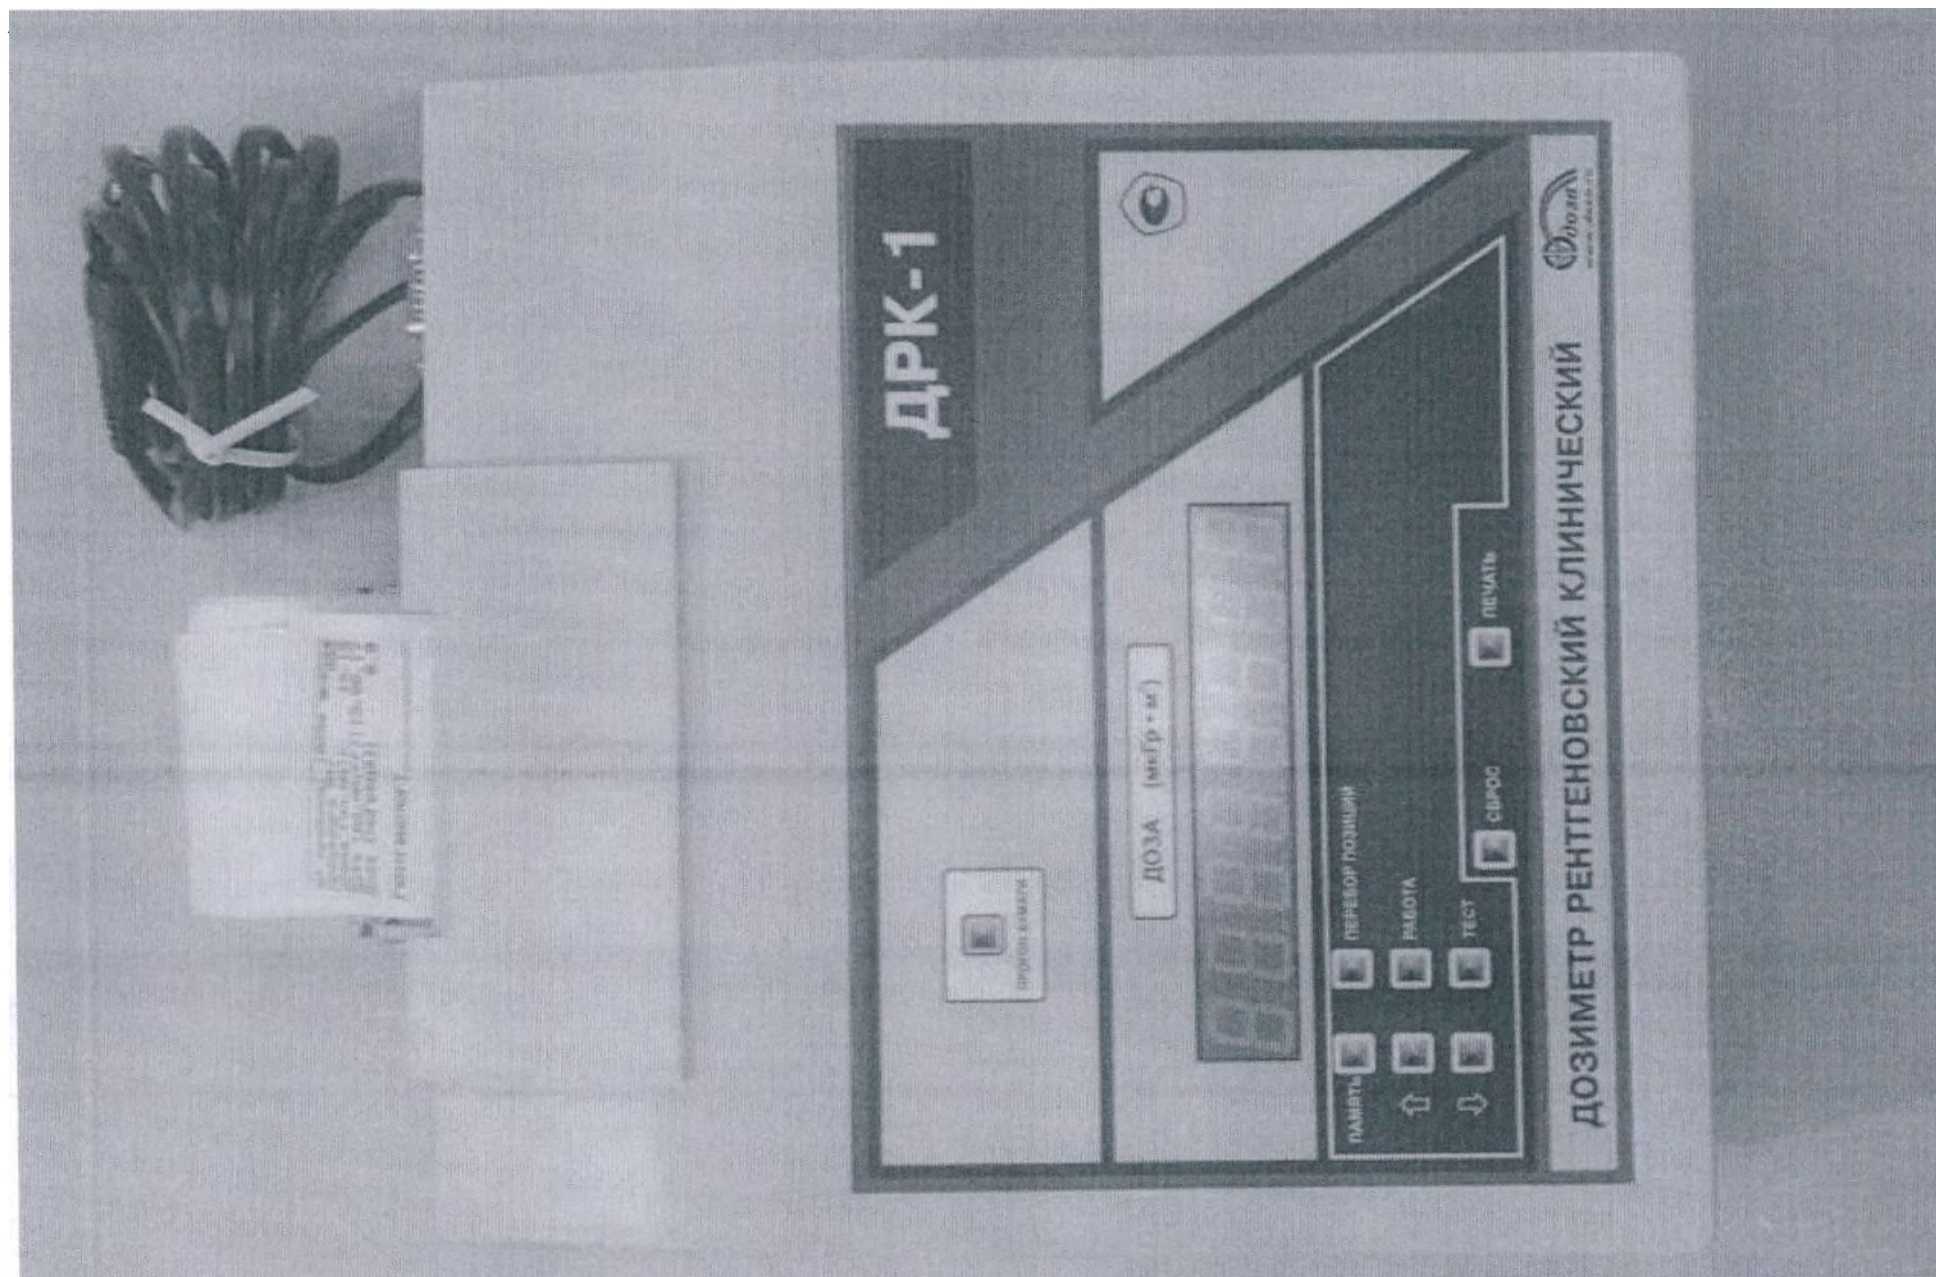


или дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия (РУ № ФСЗ 2012/11816);

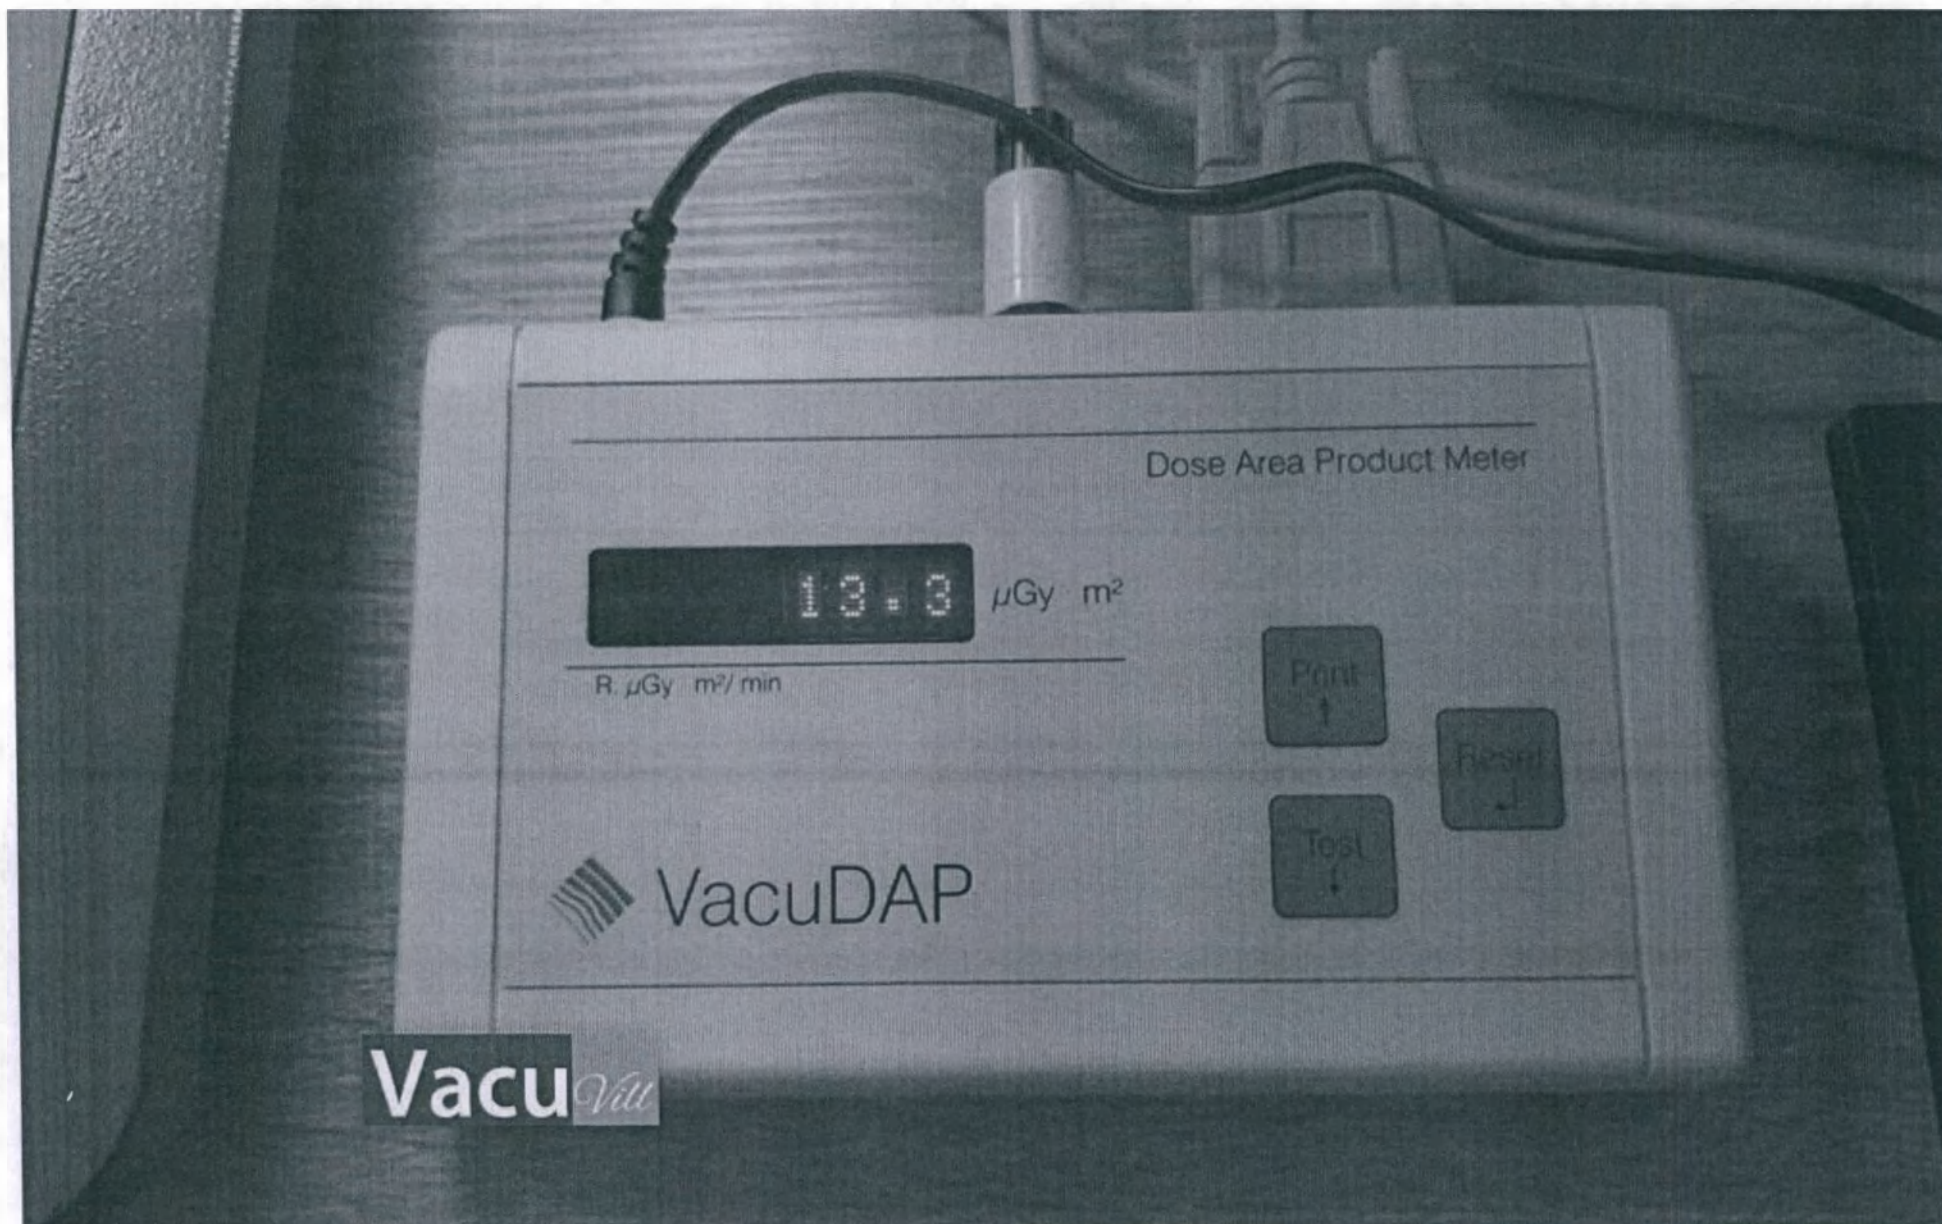


или Кермах производства IBA Dosimetry GmbH, Германия.



12. Комплект кассет, производства ЗАО «Ренекс», Российская Федерация.

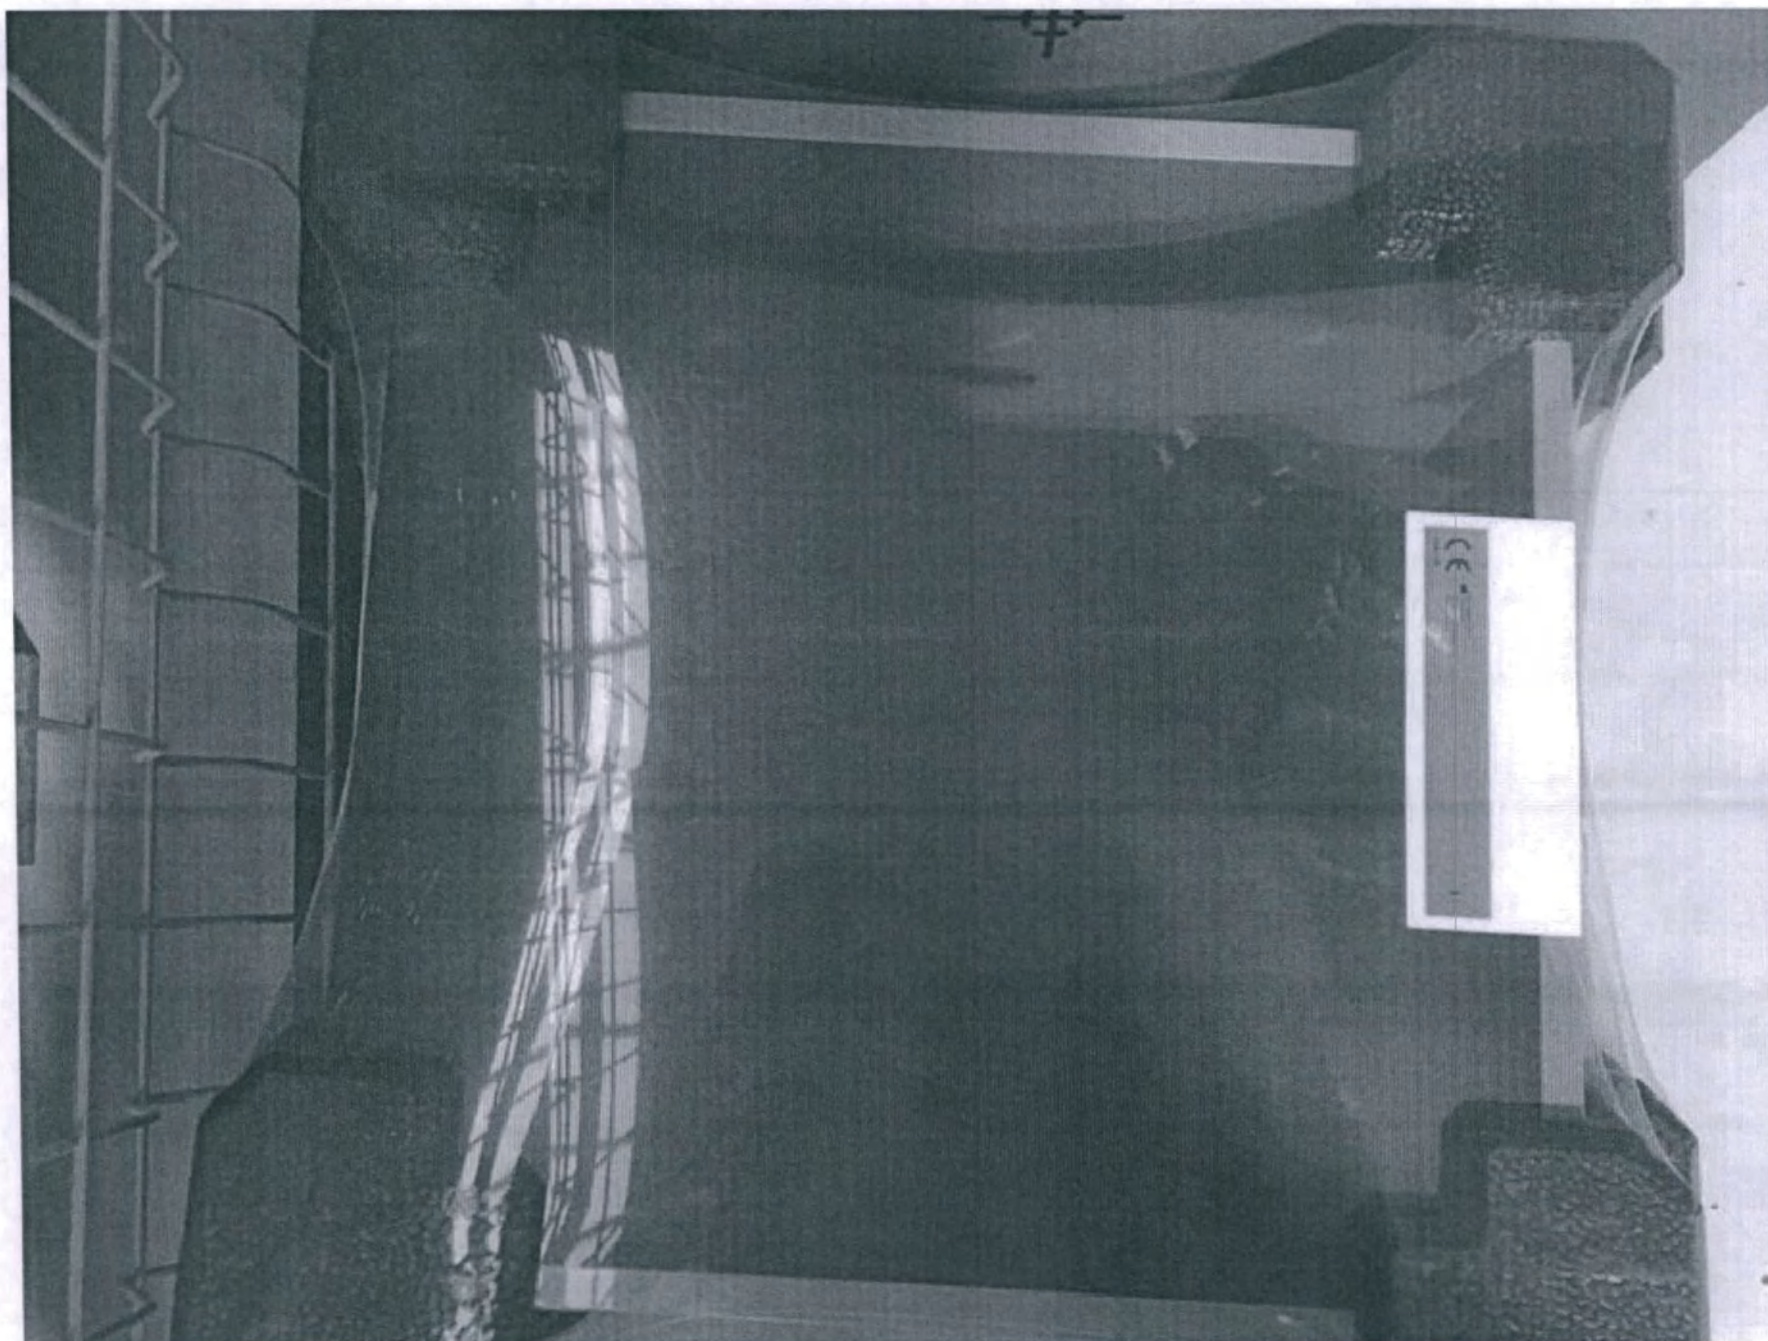


13. Комплекс цифровой CR диагностический для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений (CR 30-Xm или CR 10-X) (ПУ № РЗН 2015/2731) или система компьютерной рентгенографии CR (CR 12-X или CR 15-X) (ПУ № РЗН 2015/3346); или комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений (DX-M или DX-G) (ПУ № ФСЗ 2011/09003) производства Agfa N.V., Бельгия;

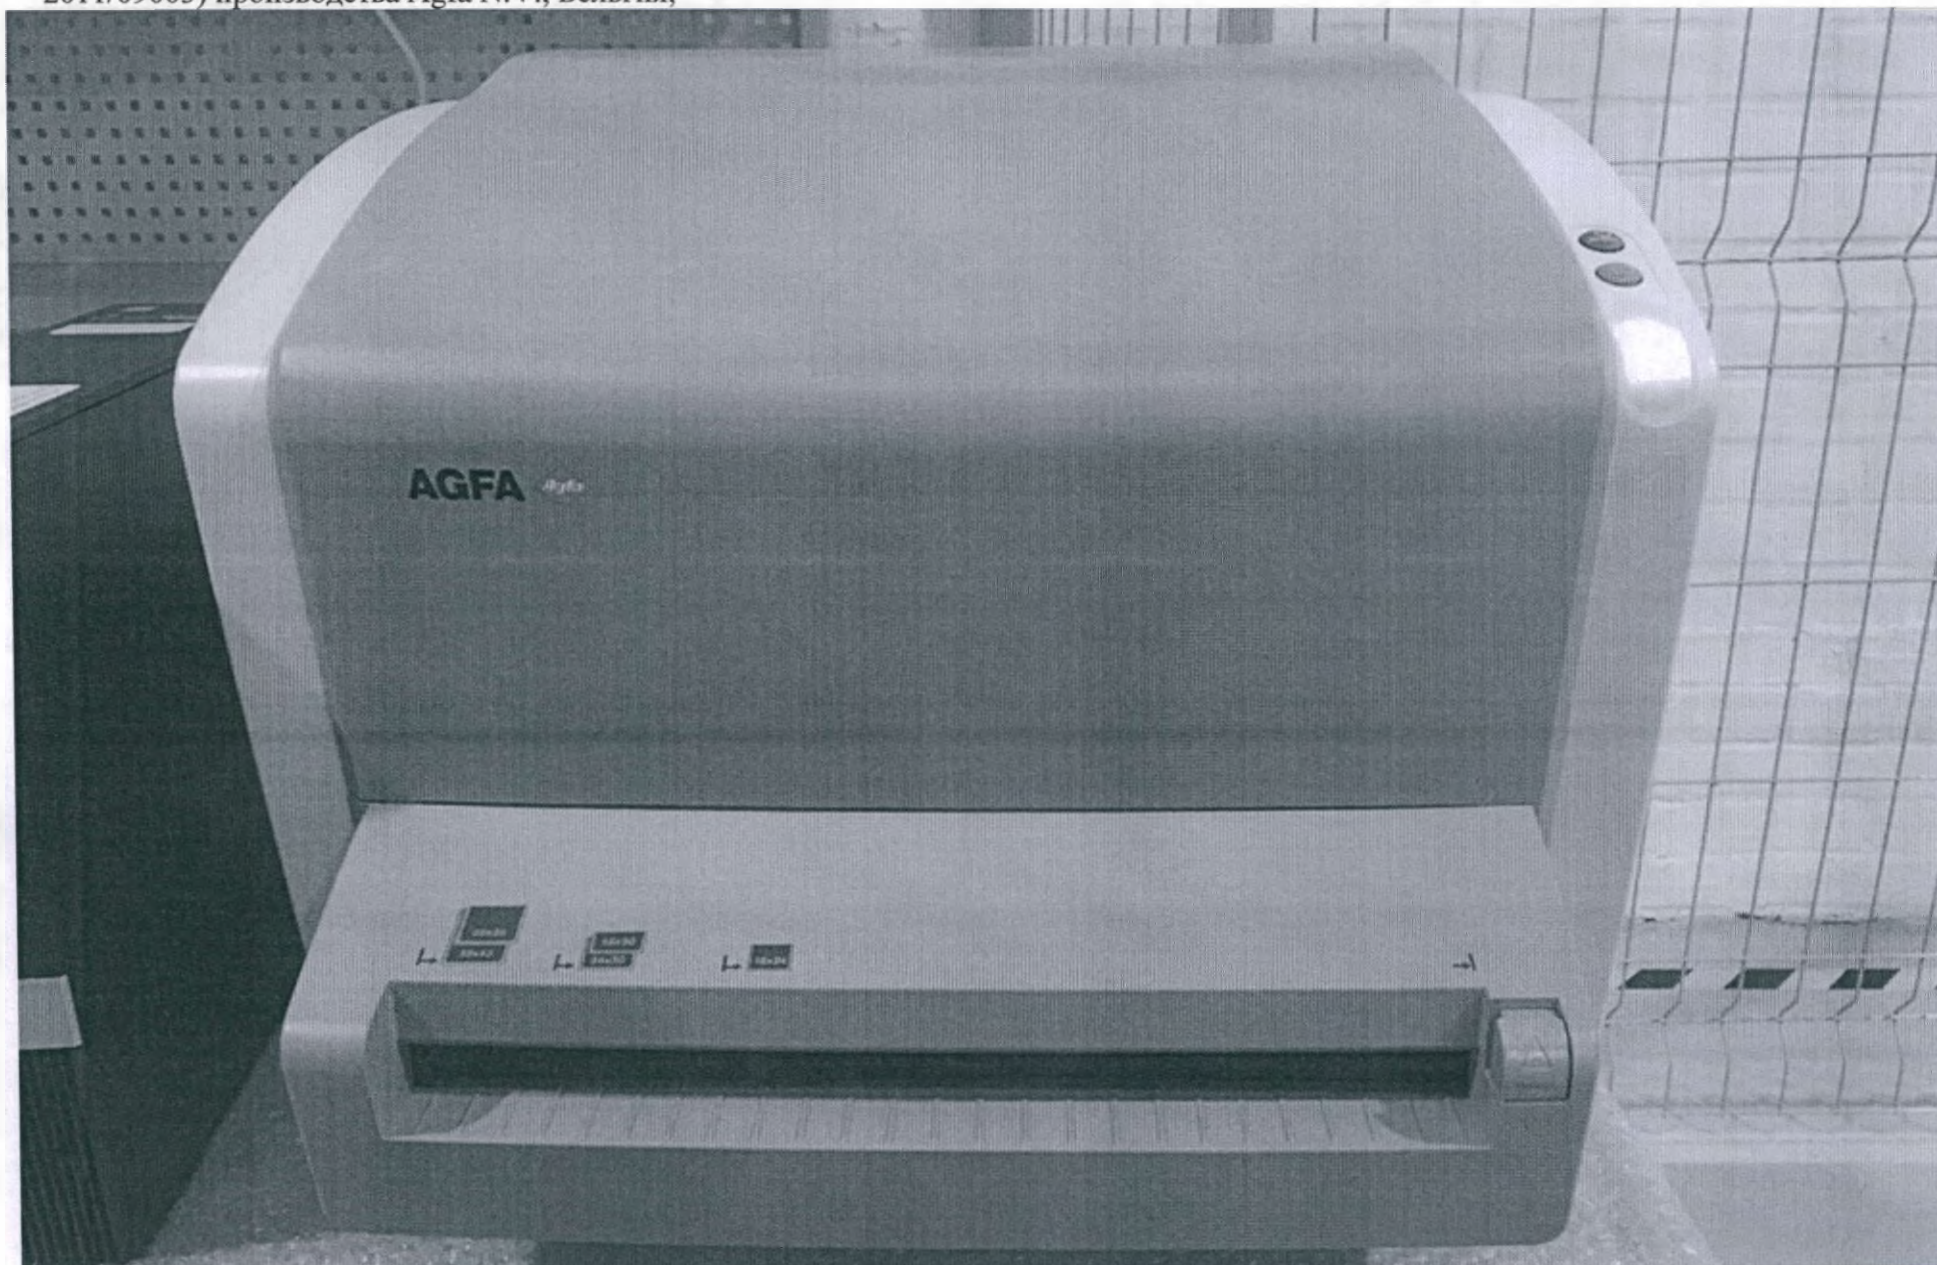


или система компьютерной радиологии REGIUS 110 (ПУ № ФСЗ 2010/06650) или REGIUS 210 (ПУ № ФСЗ 2010/06649) или REGIUS SIGMA (ФСЗ 2011/10738) производства Konica Minolta Medical&Graphic, Inc., Япония;




или система цифровой радиографии Vita Flex CR System (РУ № РЗН 2017/5376) или Vita XE или серии CR System исполнения: Classic, Elite (РУ № ФСЗ 2010/08204) производства Carestream Health Inc., США;

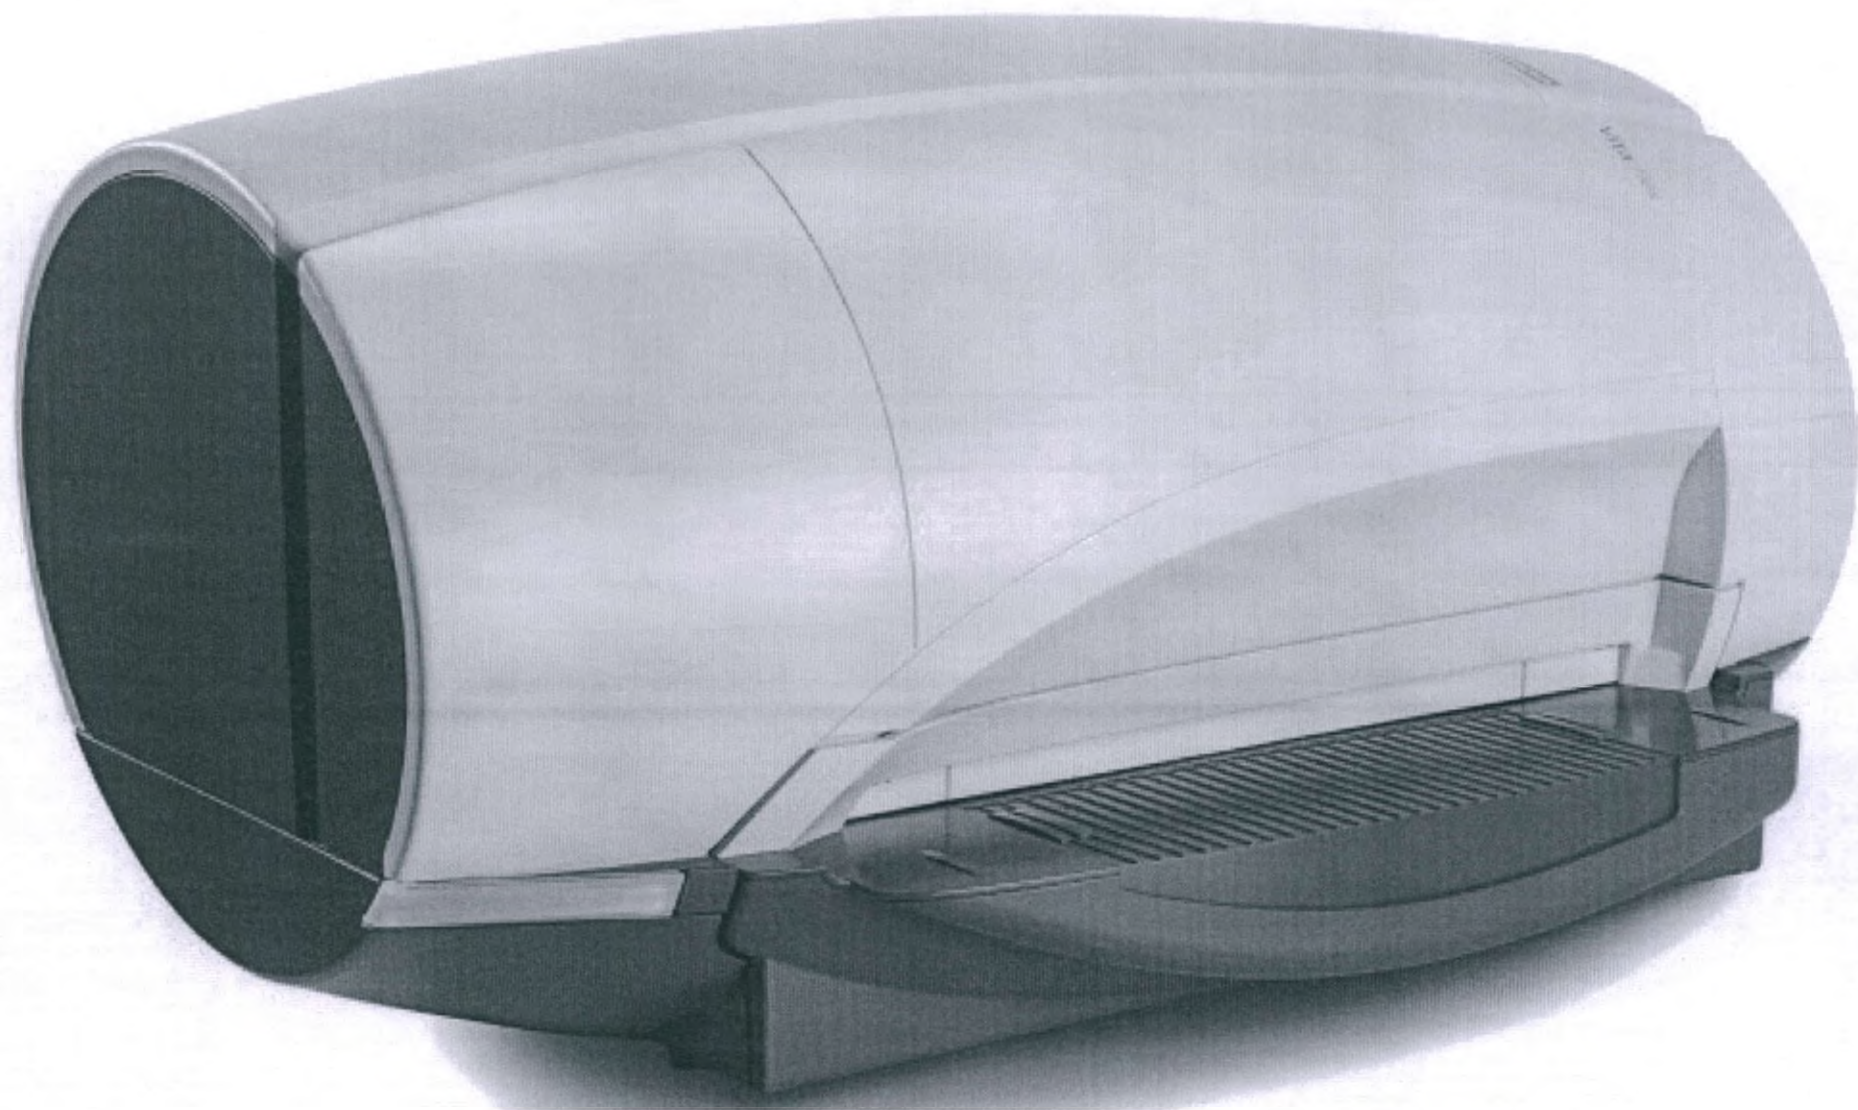

или Аппарат цифровой радиологии на основе восстанавливаемых люминофоров, модели: FCR Capsula X (CR-IR 357), FCR Capsula XL (CR-IR 356), FCR Profect One (CR-IR 368), FCR XG1 (CR-IR 346), FCR XG5000 (CR-IR 362), FCR Profect CS (CR-IR 363) (ПУ № ФСЗ 2007/00091) или FCR Prima T (CR-IR 392) (ПУ № РЗН 2013/910) или устройство для цифровой радиологии на основе фотостимулируемых люминофоров FCR Capsula XL2 (CR-IR 359) (ПУ № ФСЗ 2009/04740) или FCR PROPECT CS Plus производства Fujifilm Corporation, Япония;

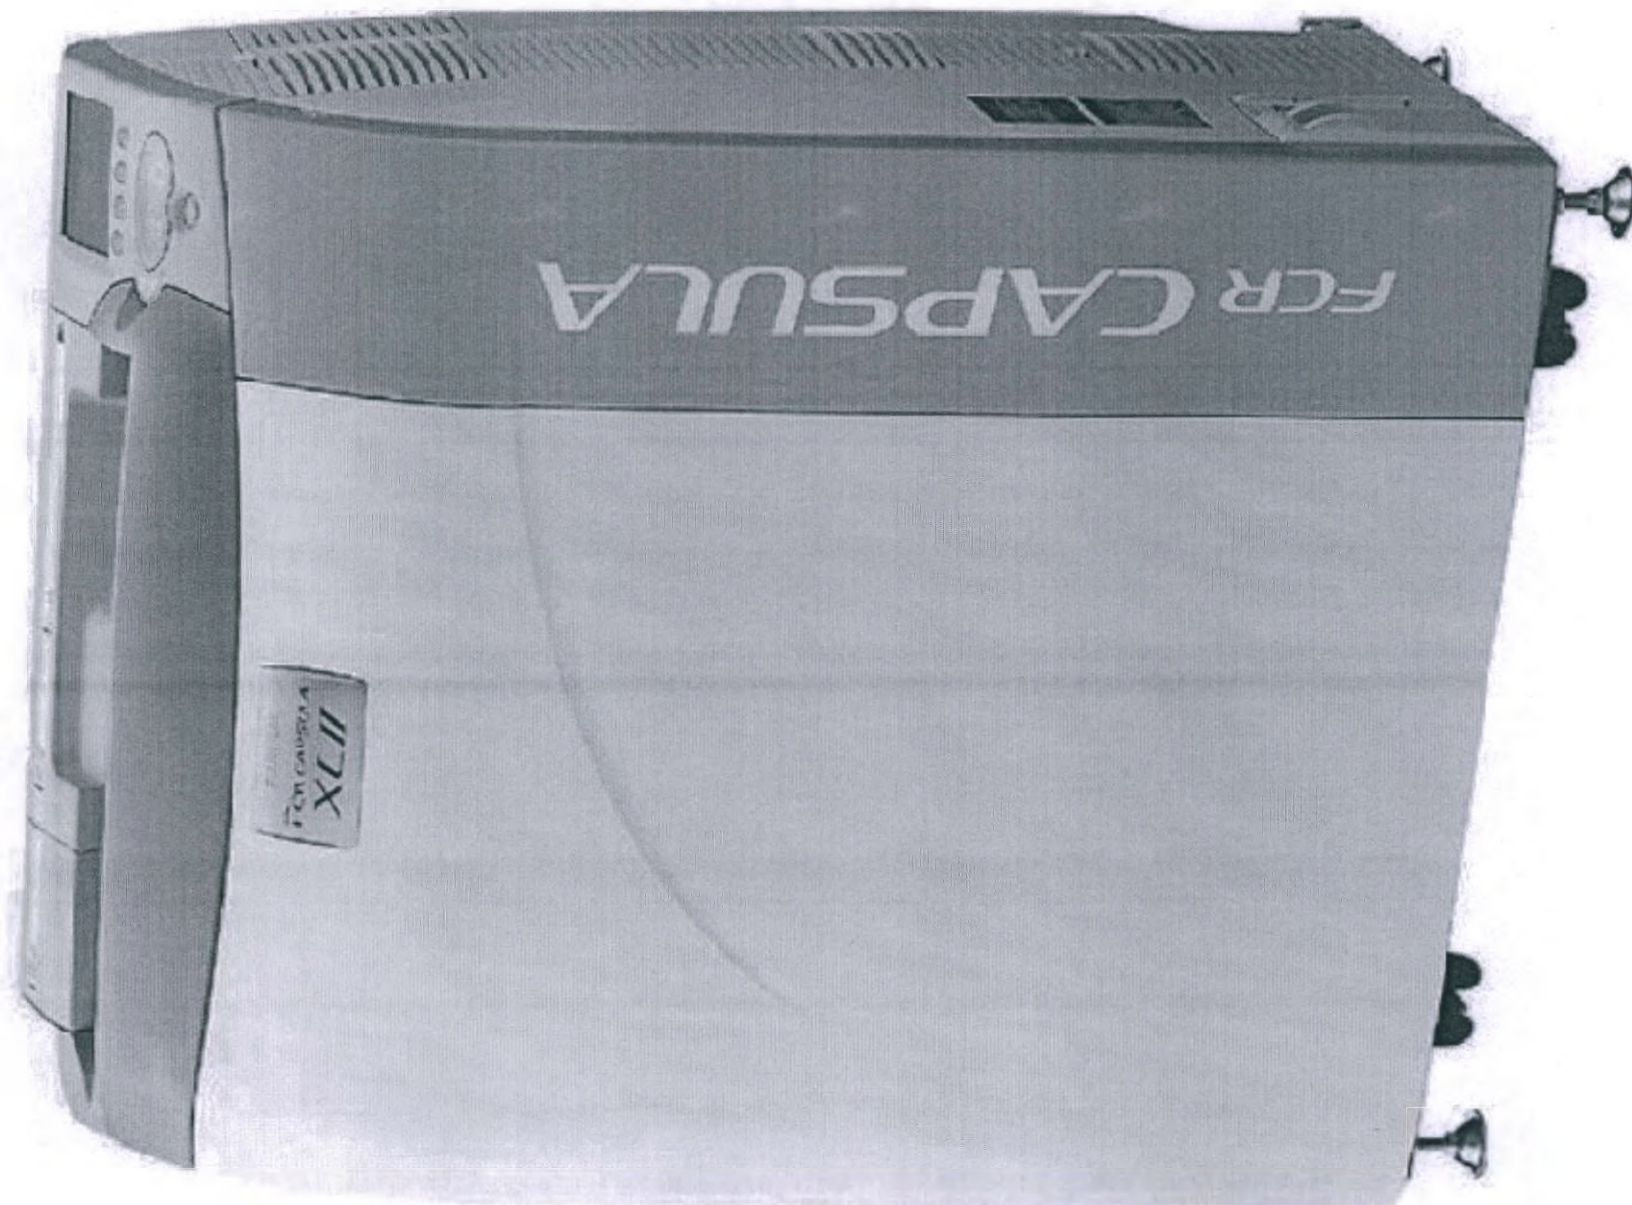


или CR 3600 или CR Chrome производства iCRco Inc., США;

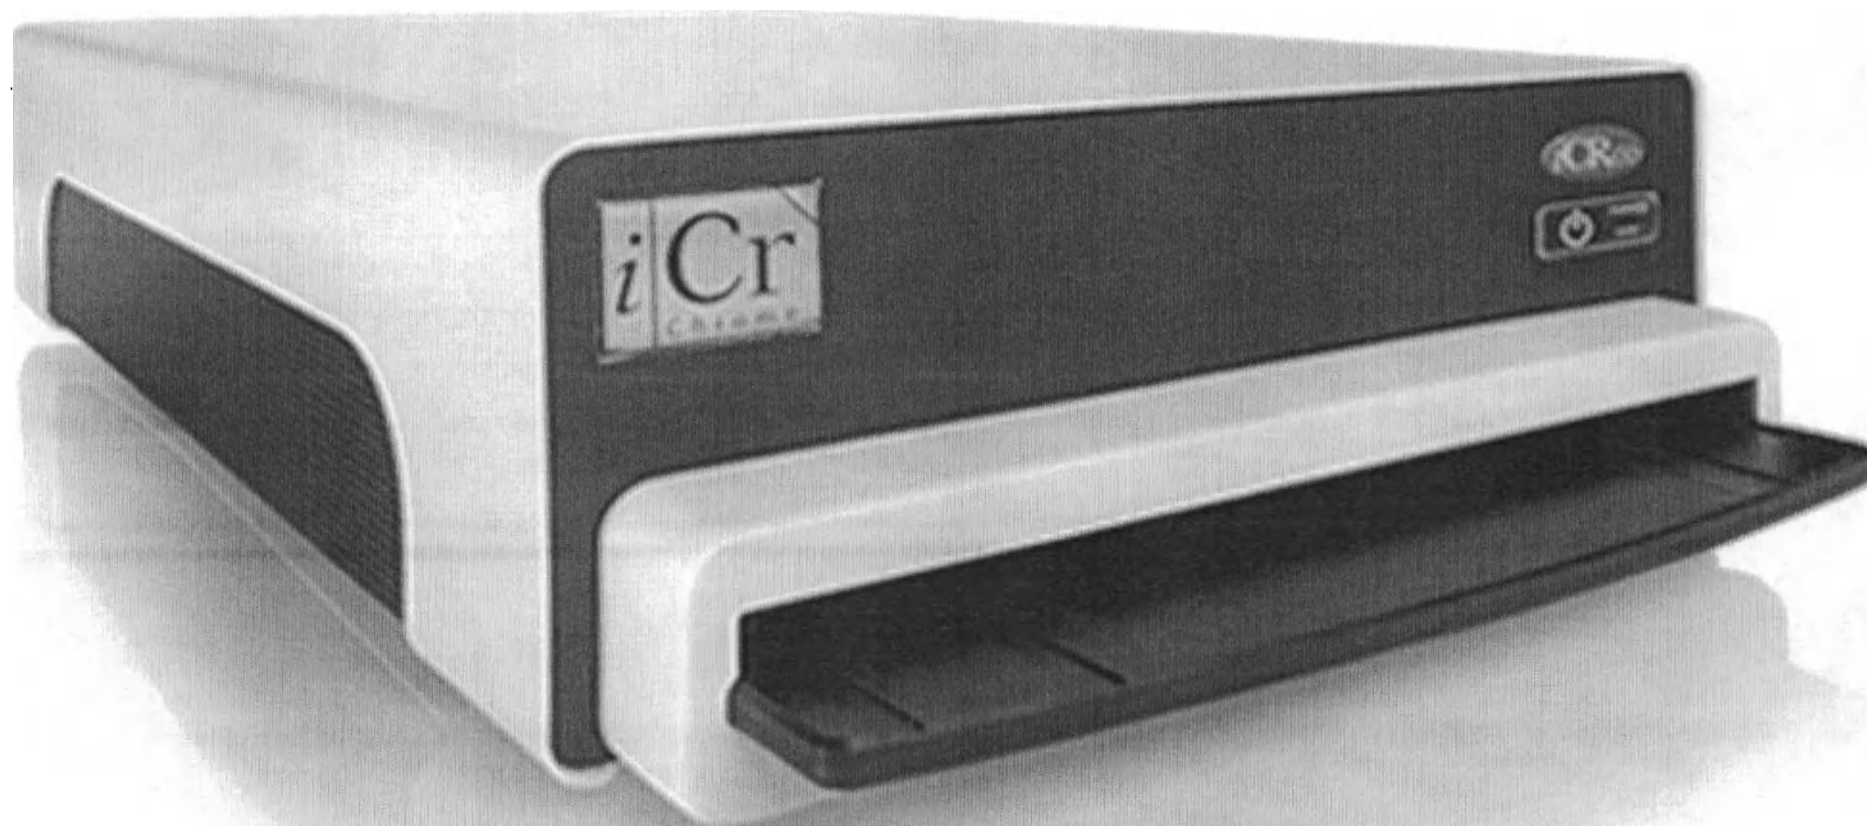


или аппарат компьютерной радиологии FireCR Spark производства 3D Imaging & Simulations Corp. (3DISC), США (РУ № РЗН 2018/7751).




14. РМ врача-рентгенолога производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

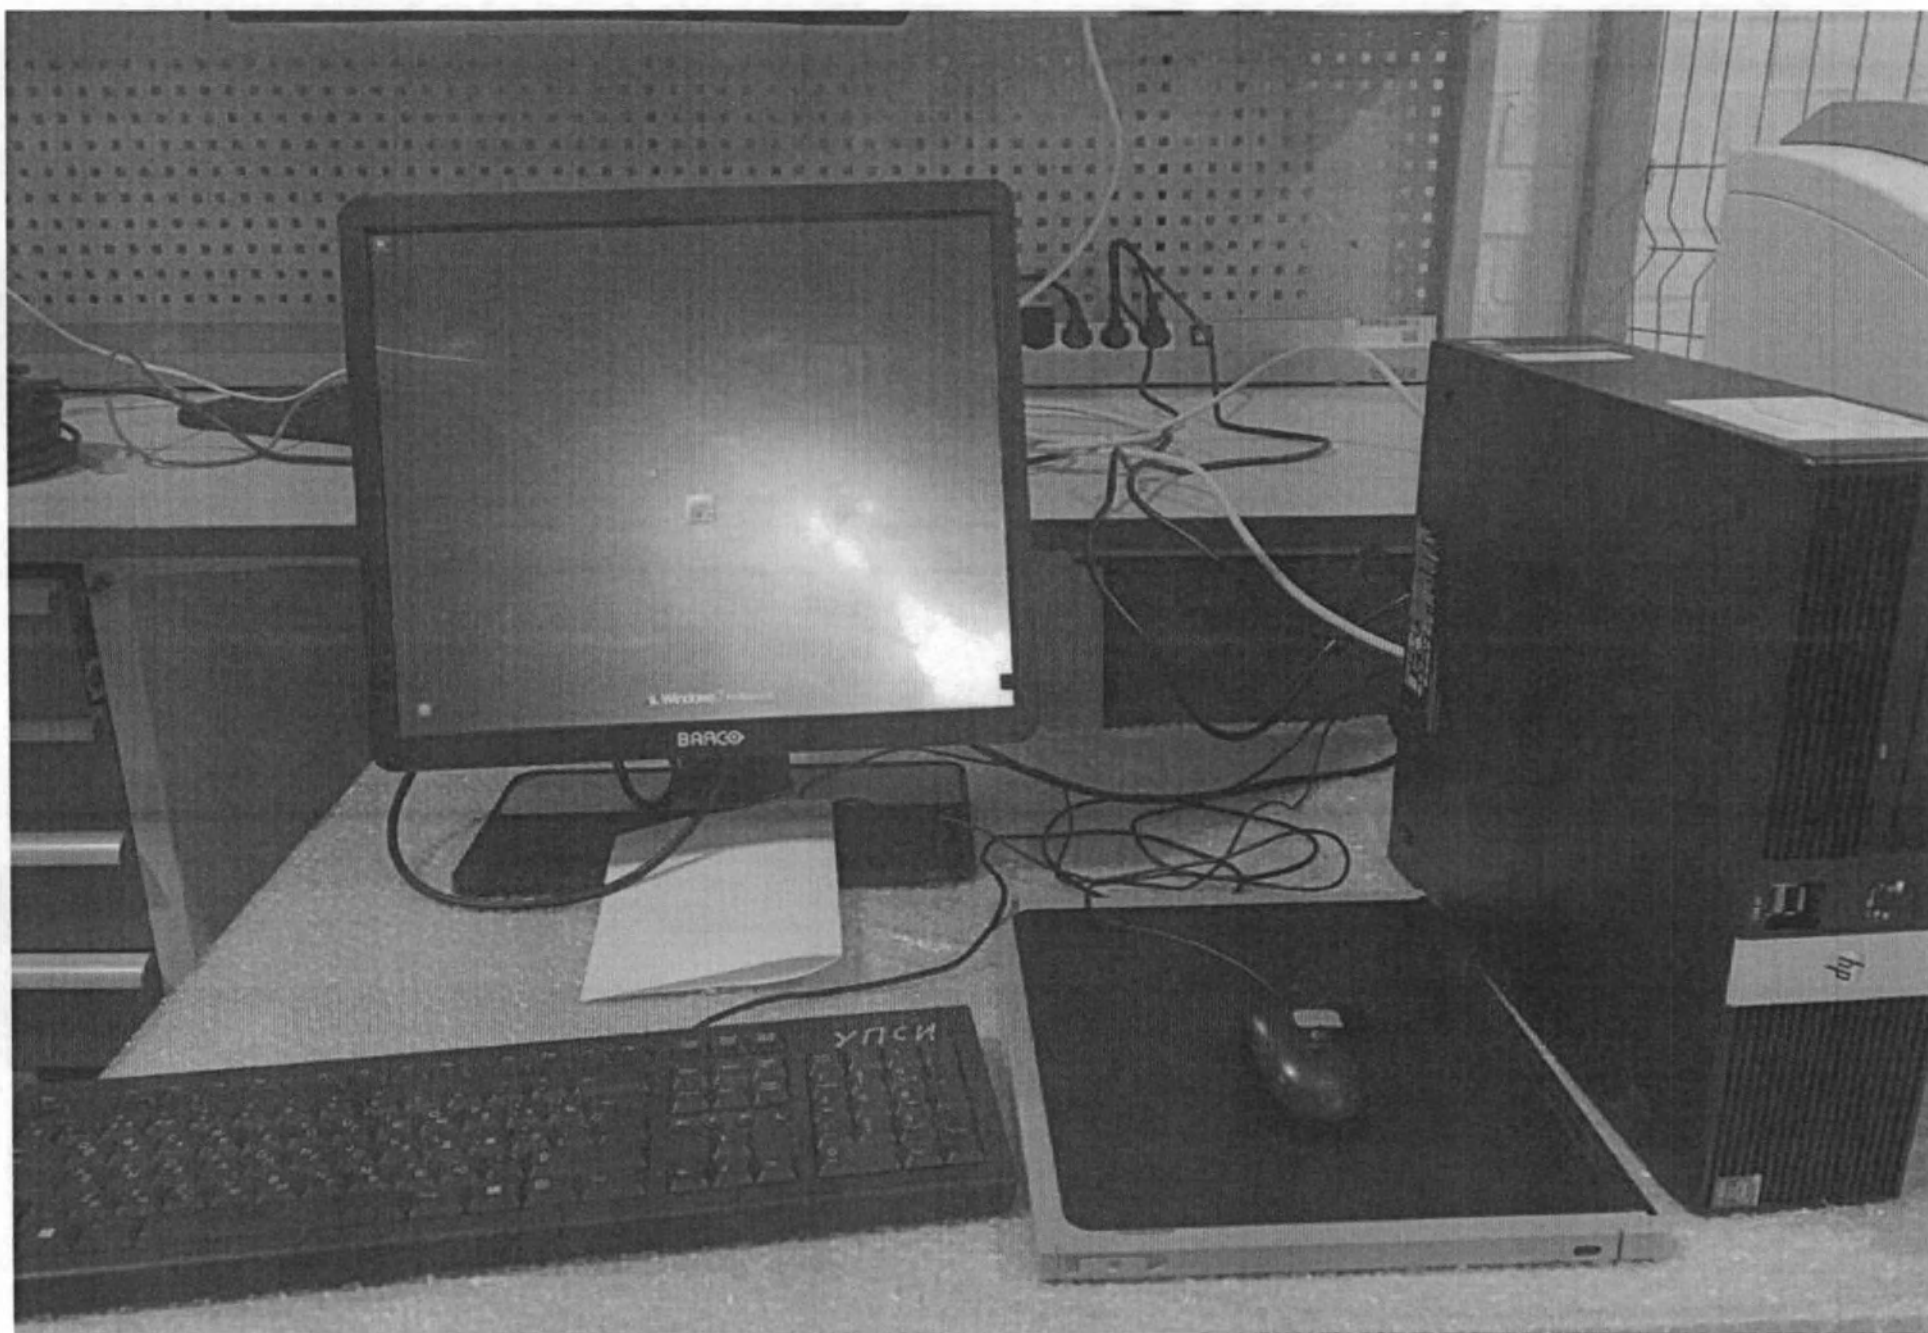

или комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007 производства ООО «МЕД-РЕЙ», Россия (РУ № ФСР 2008/02715).

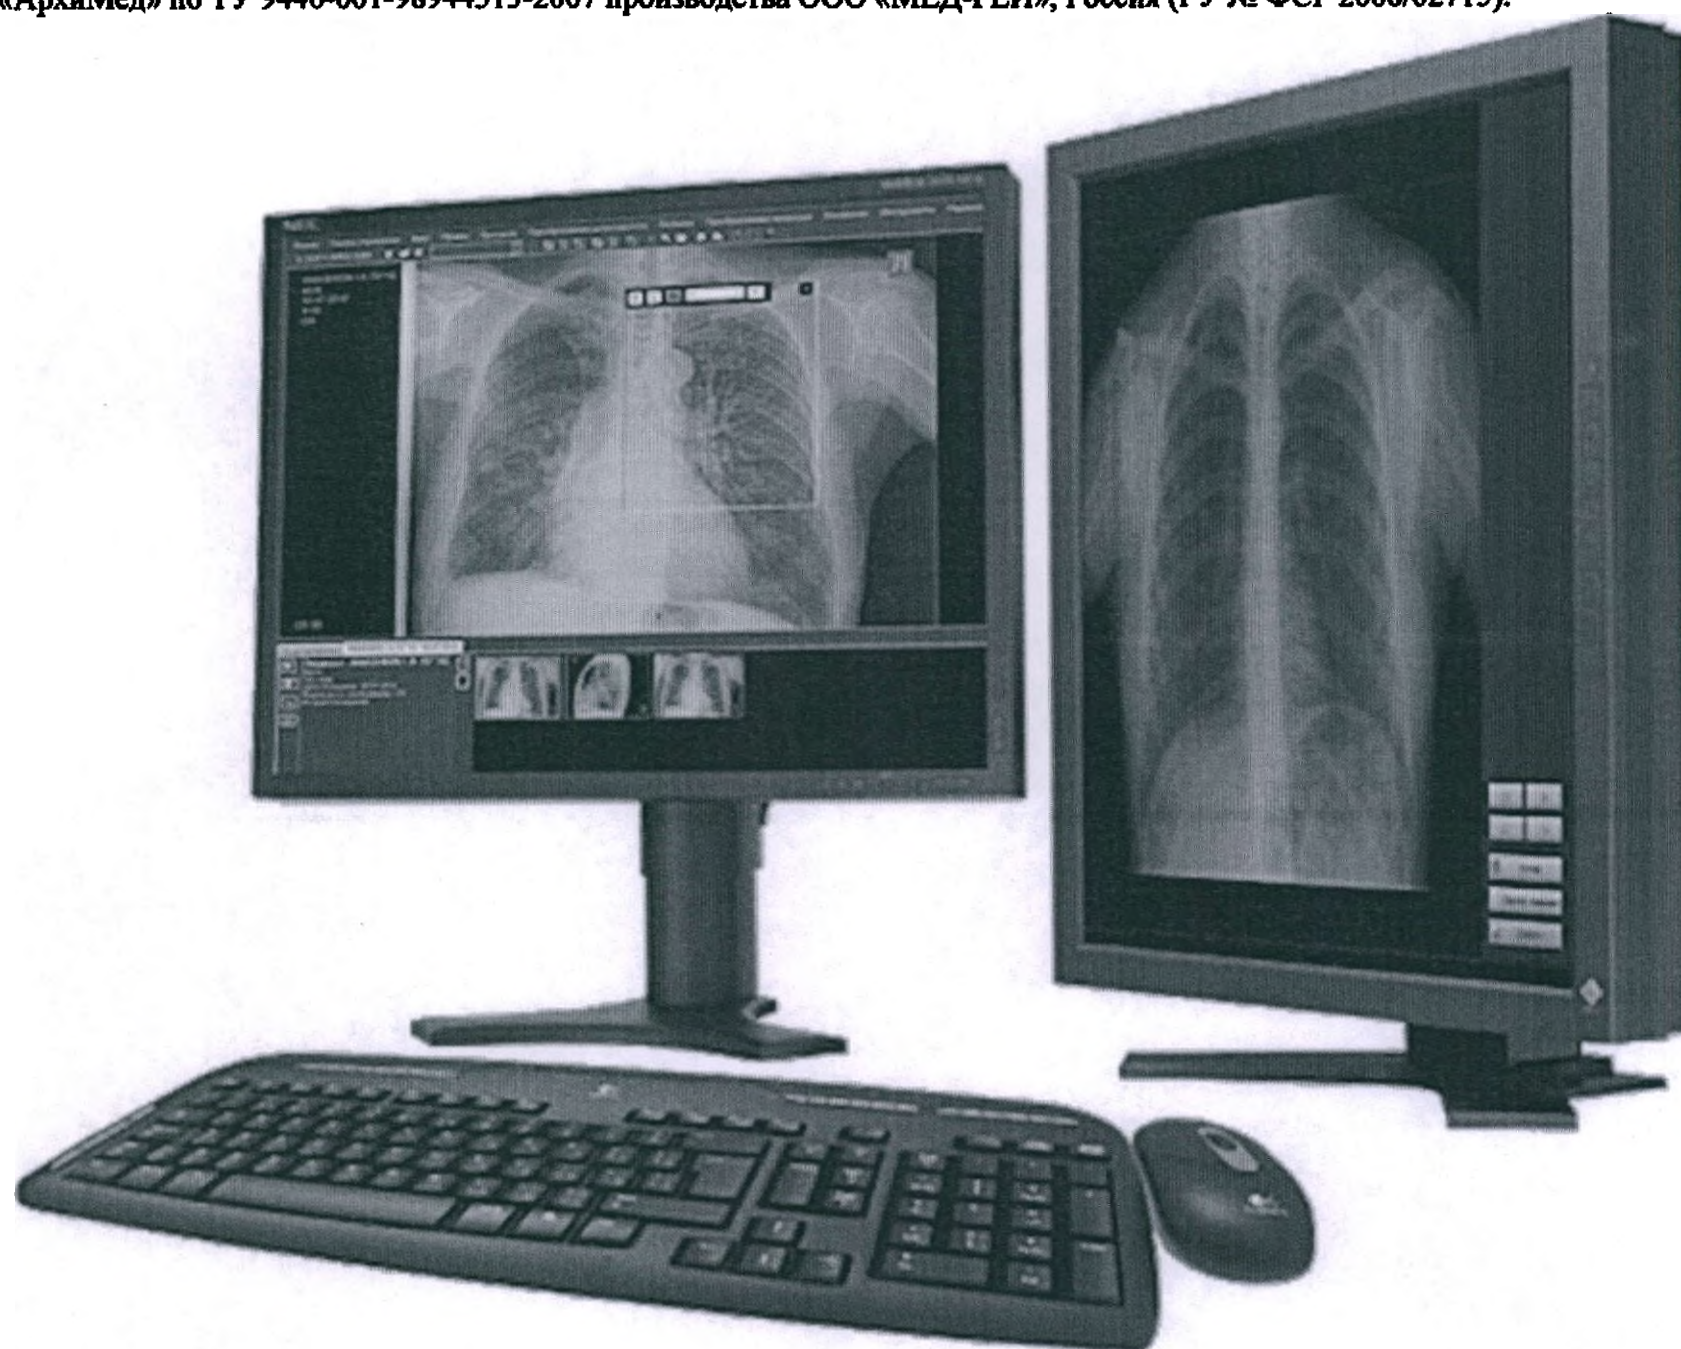

15. Камера мультиматная термографическая Drystar Axys или Drystar 5302 (ПУ № ФСЗ 2008/02792) или Drystar 5503 производства Agfa N.V., Бельгия;

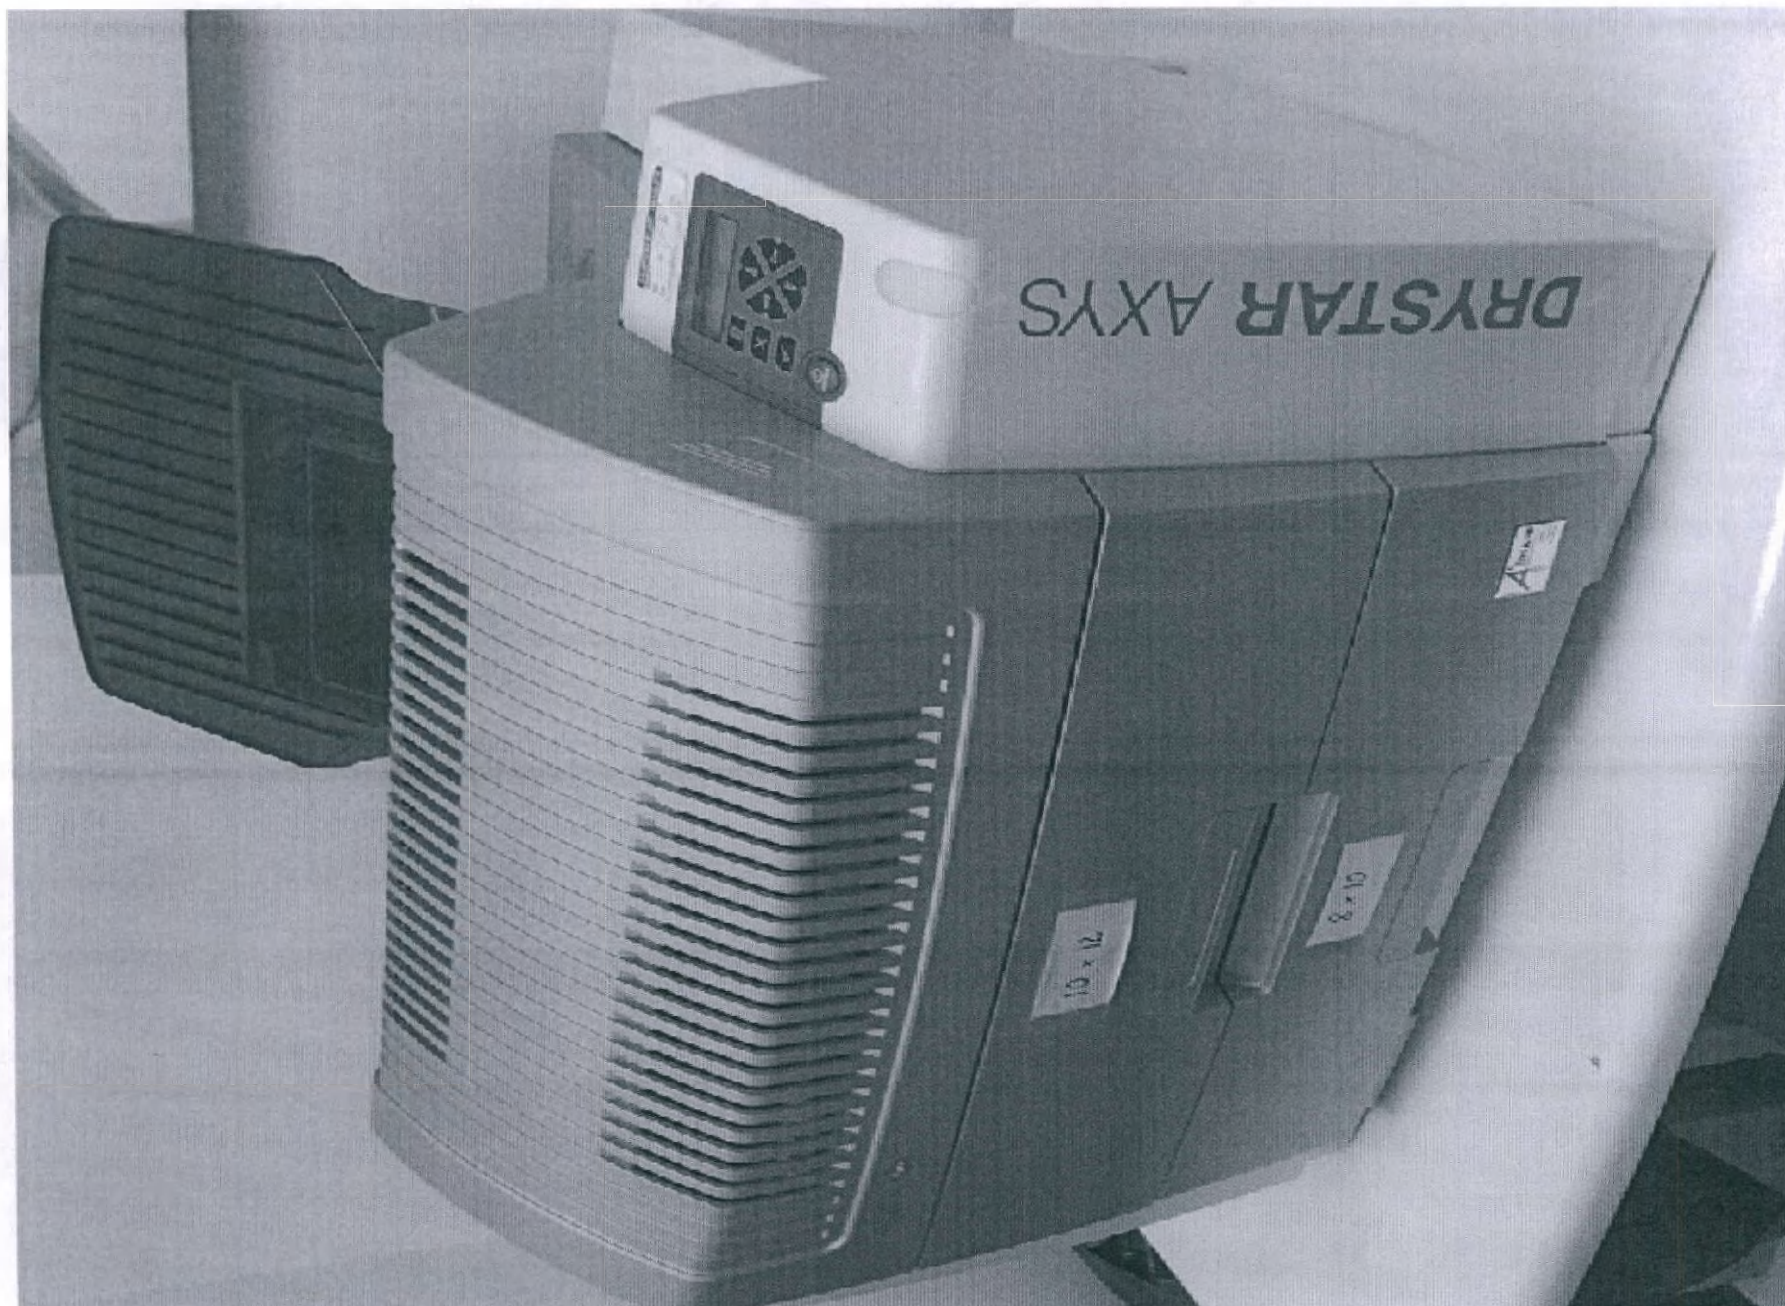


или камера медицинская термографическая мультиматная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite (ПУ № РЗН 2013/911) или камера медицинская лазерная мультиматная DRYPIX 4000 исполнения DRYPIX Plus (ПУ № ФСЗ 2012/12949) производства Fujifilm Corporation, Япония;




или камера лазерная мультиформатная TRIMAX TX55 Laser Imaging System (ПУ № РЗН 2016/4667) или камера лазерная мультиформатная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений (ПУ № ФСЗ 2011/10352) производства Carestream Health, Inc., США;



или устройство для печати монохромных медицинских изображений UP производства Sony Corporation, Япония (РУ ФСЗ 2011/10354).

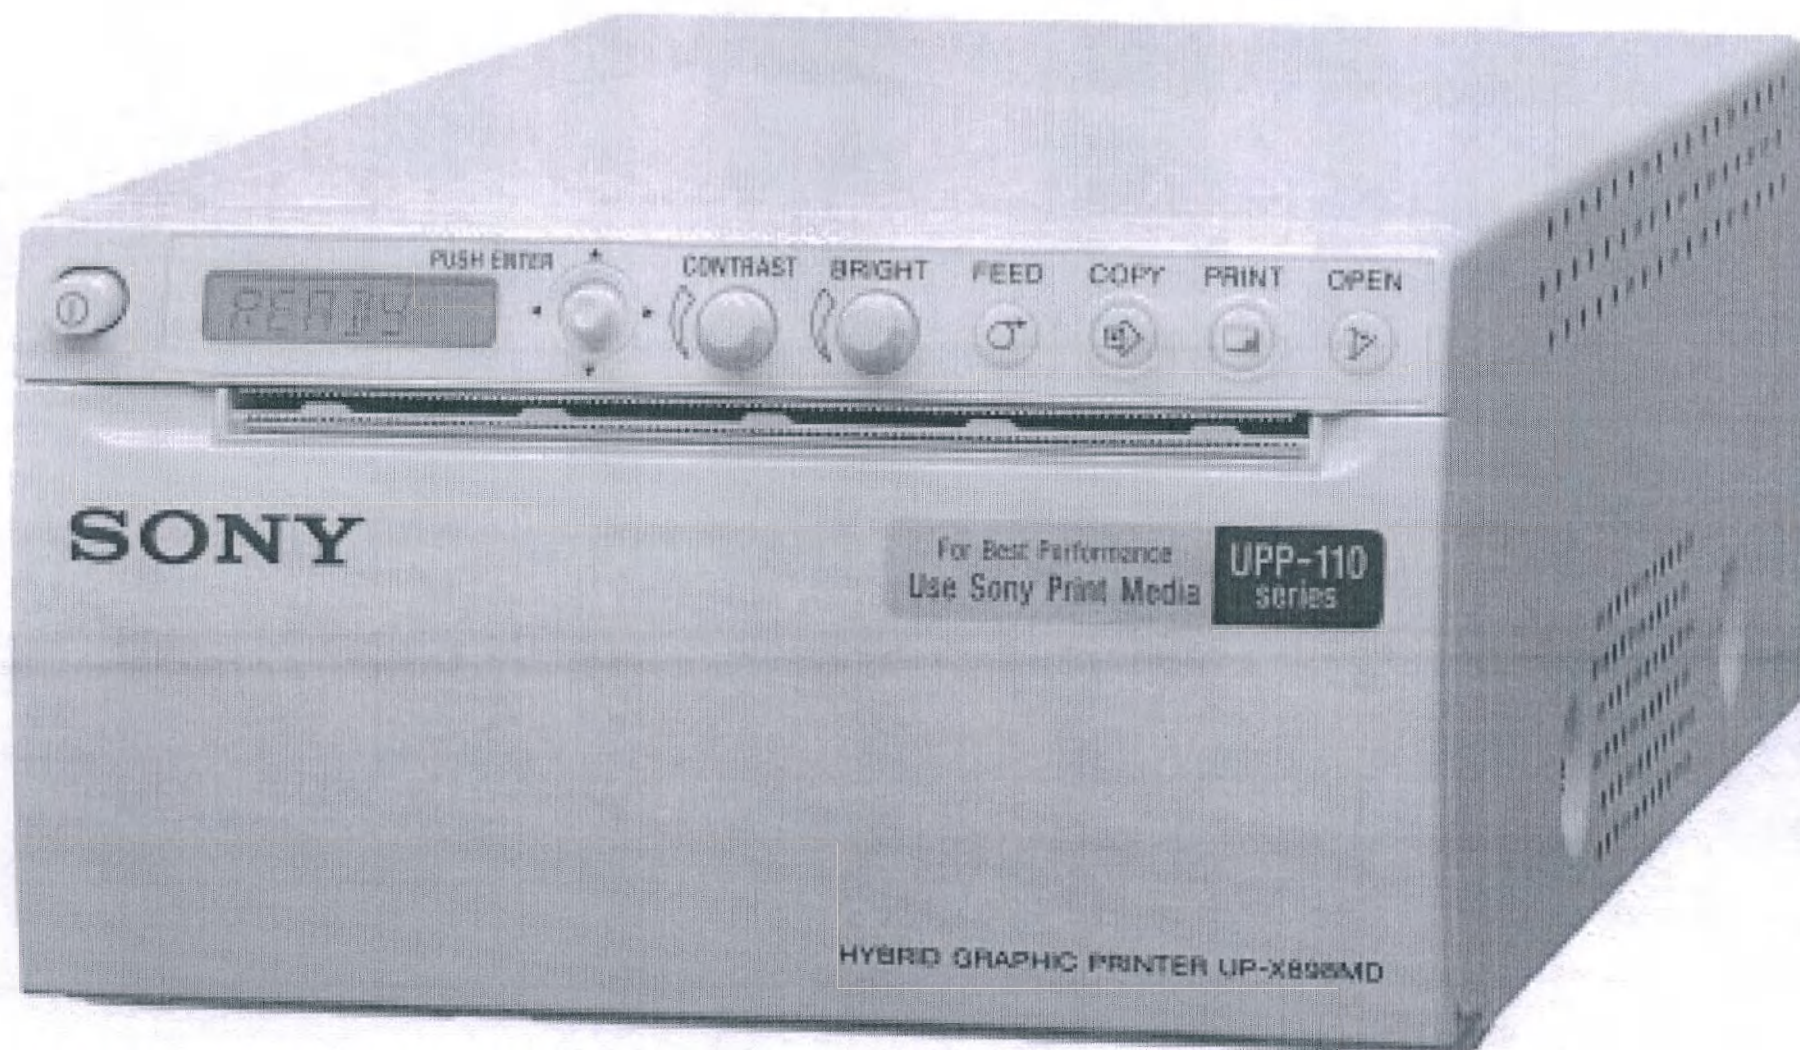


16. Система цифровой рентгенографии CXDI производства Canon Medical System Corporation, Япония;

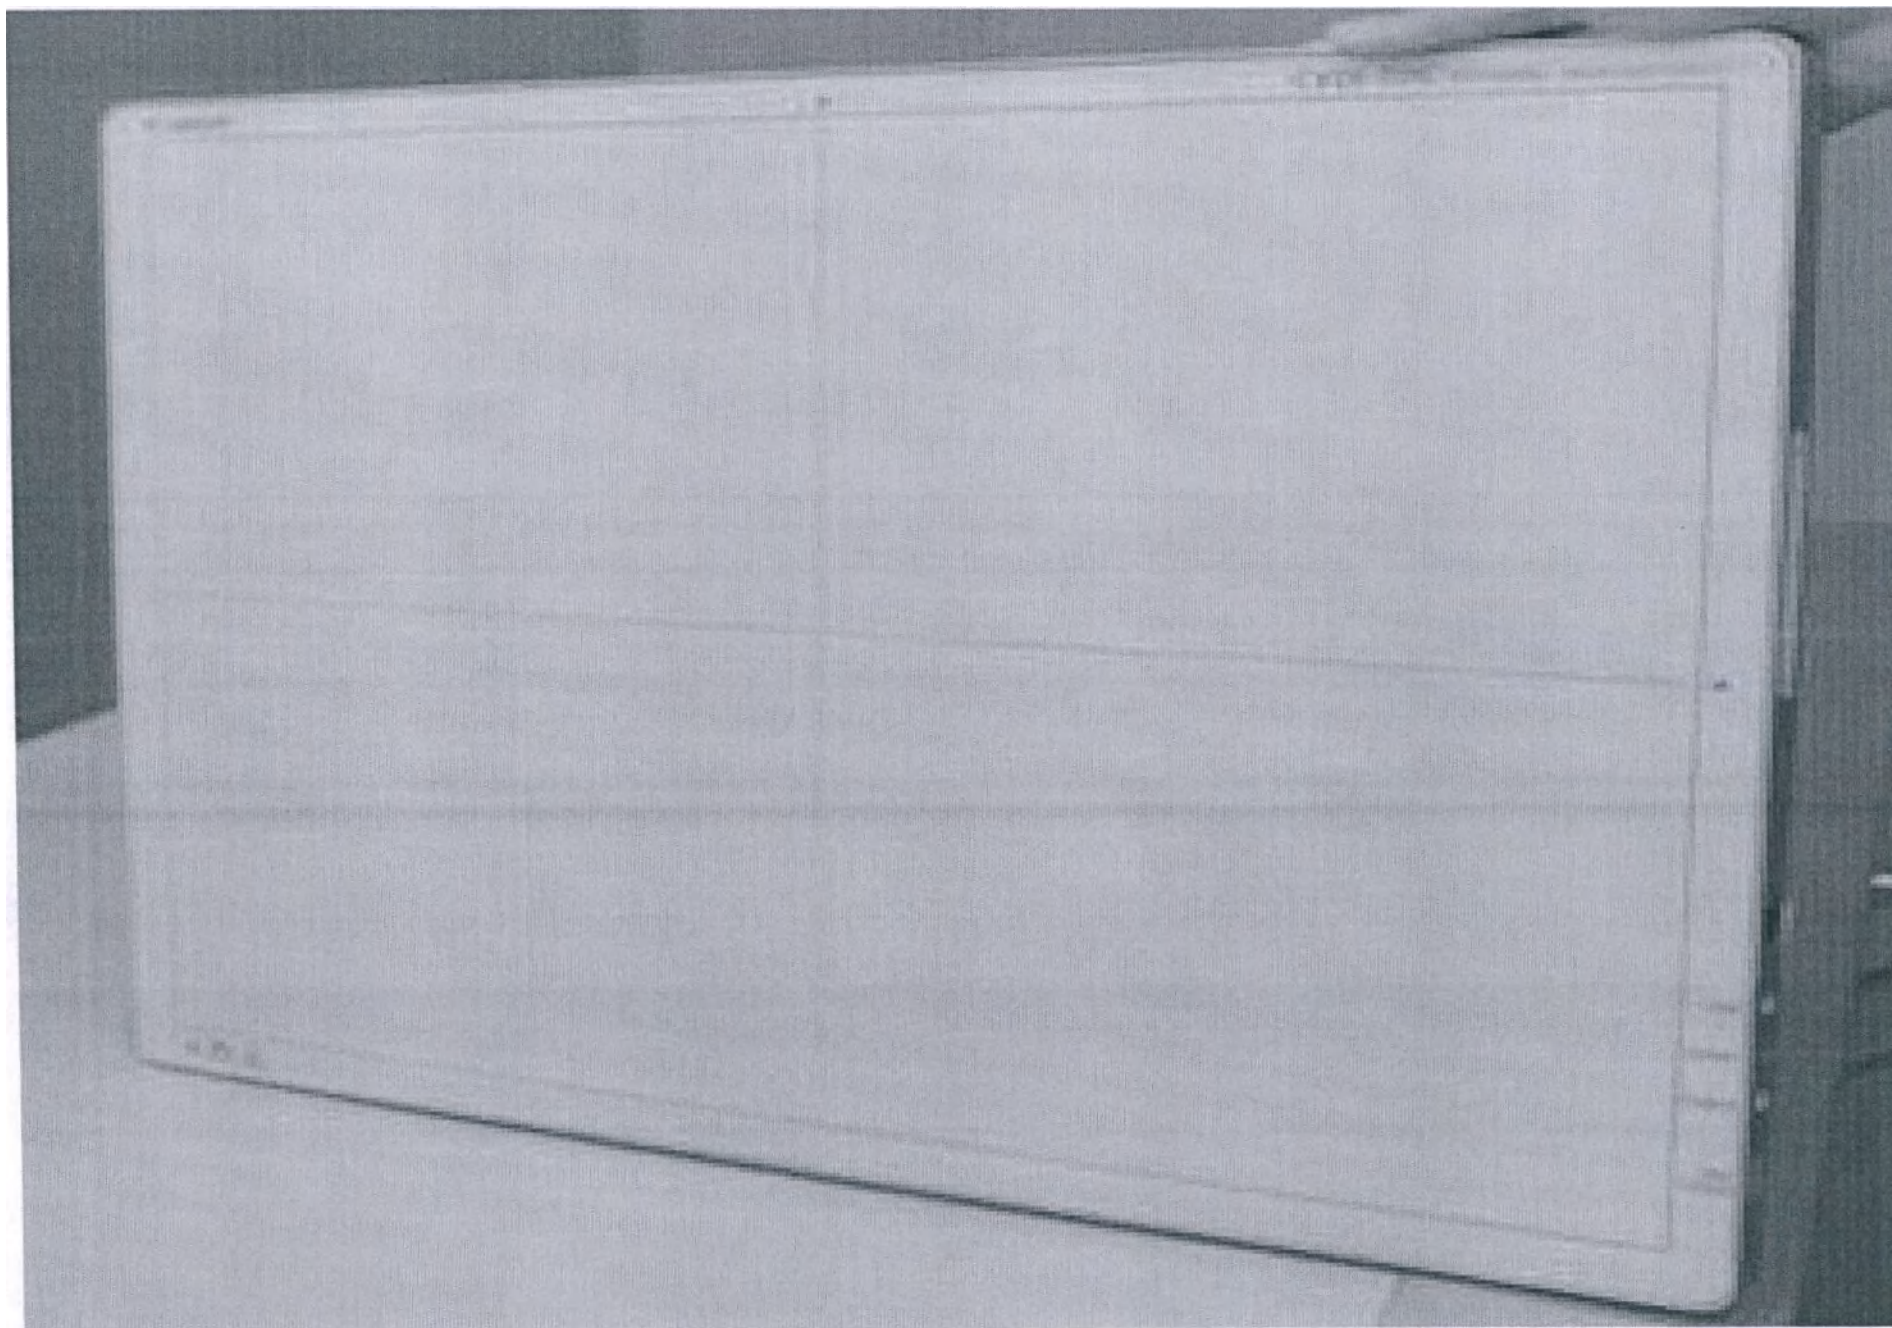

или NX производства Agfa N.V., Бельгия;




или Vxvue производства Vieworks Co., Ltd., Корея;

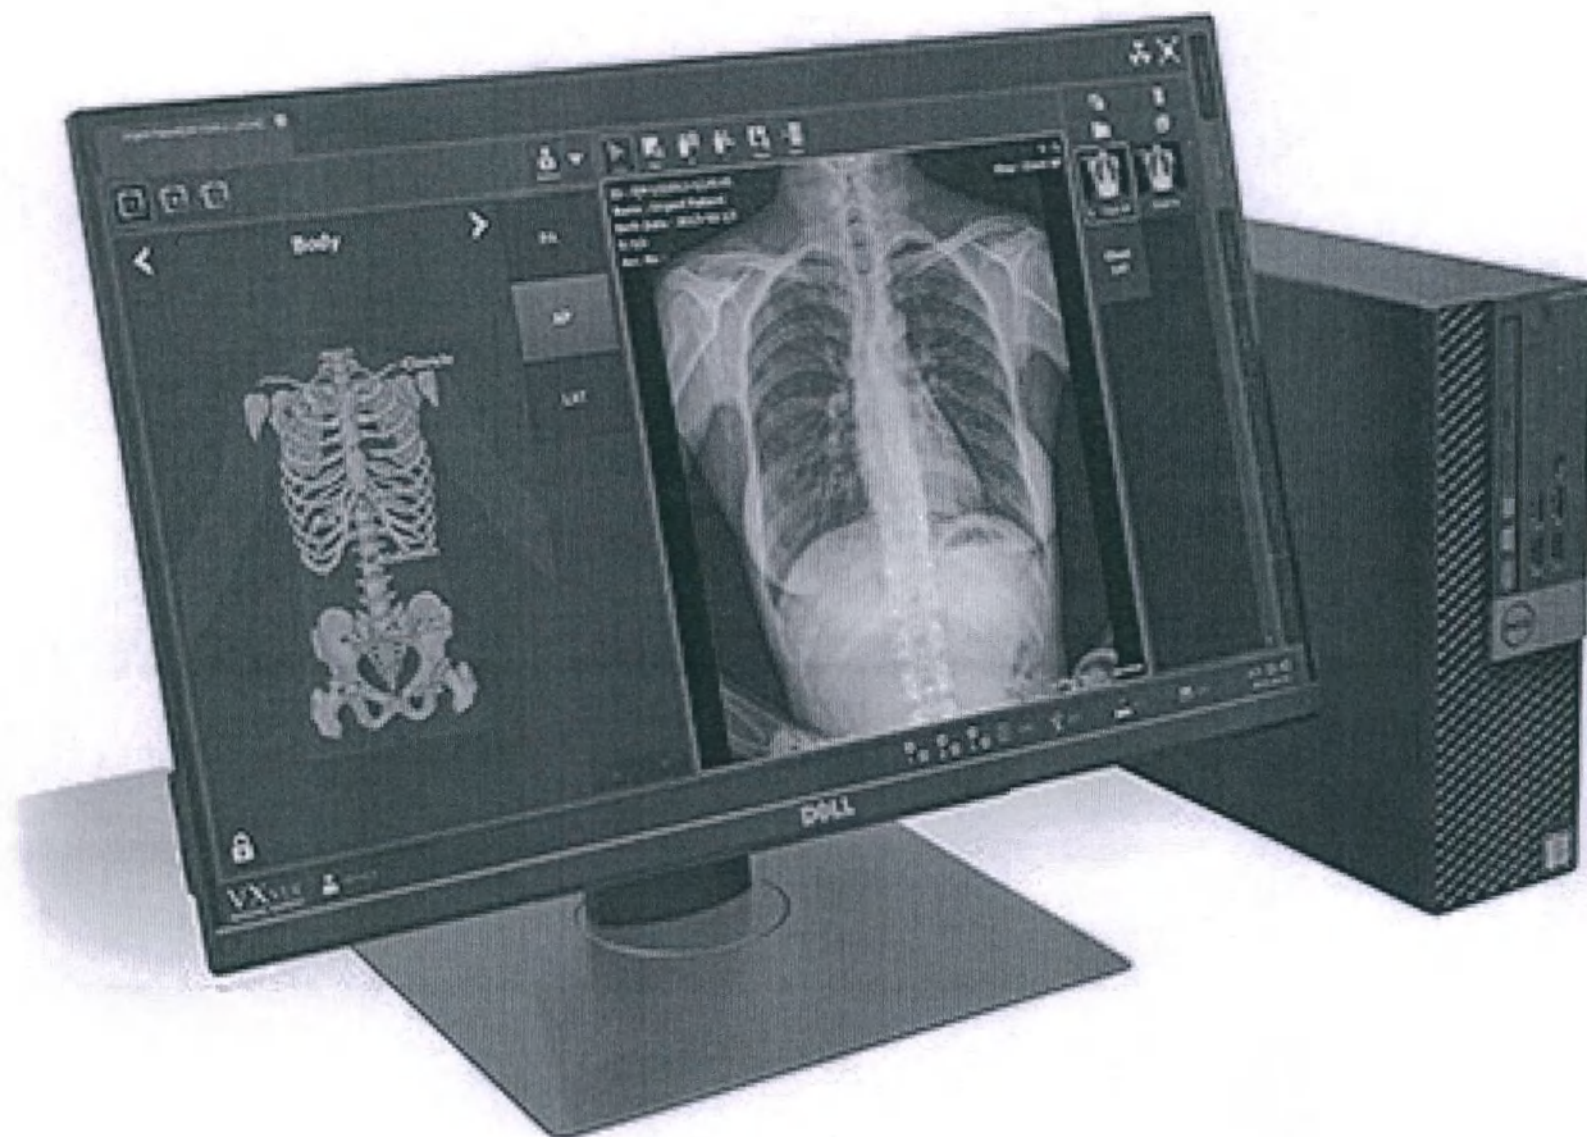


или ArtPix производства Thales Electron Devices SAS., Франция;




или CS производства Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., Япония;

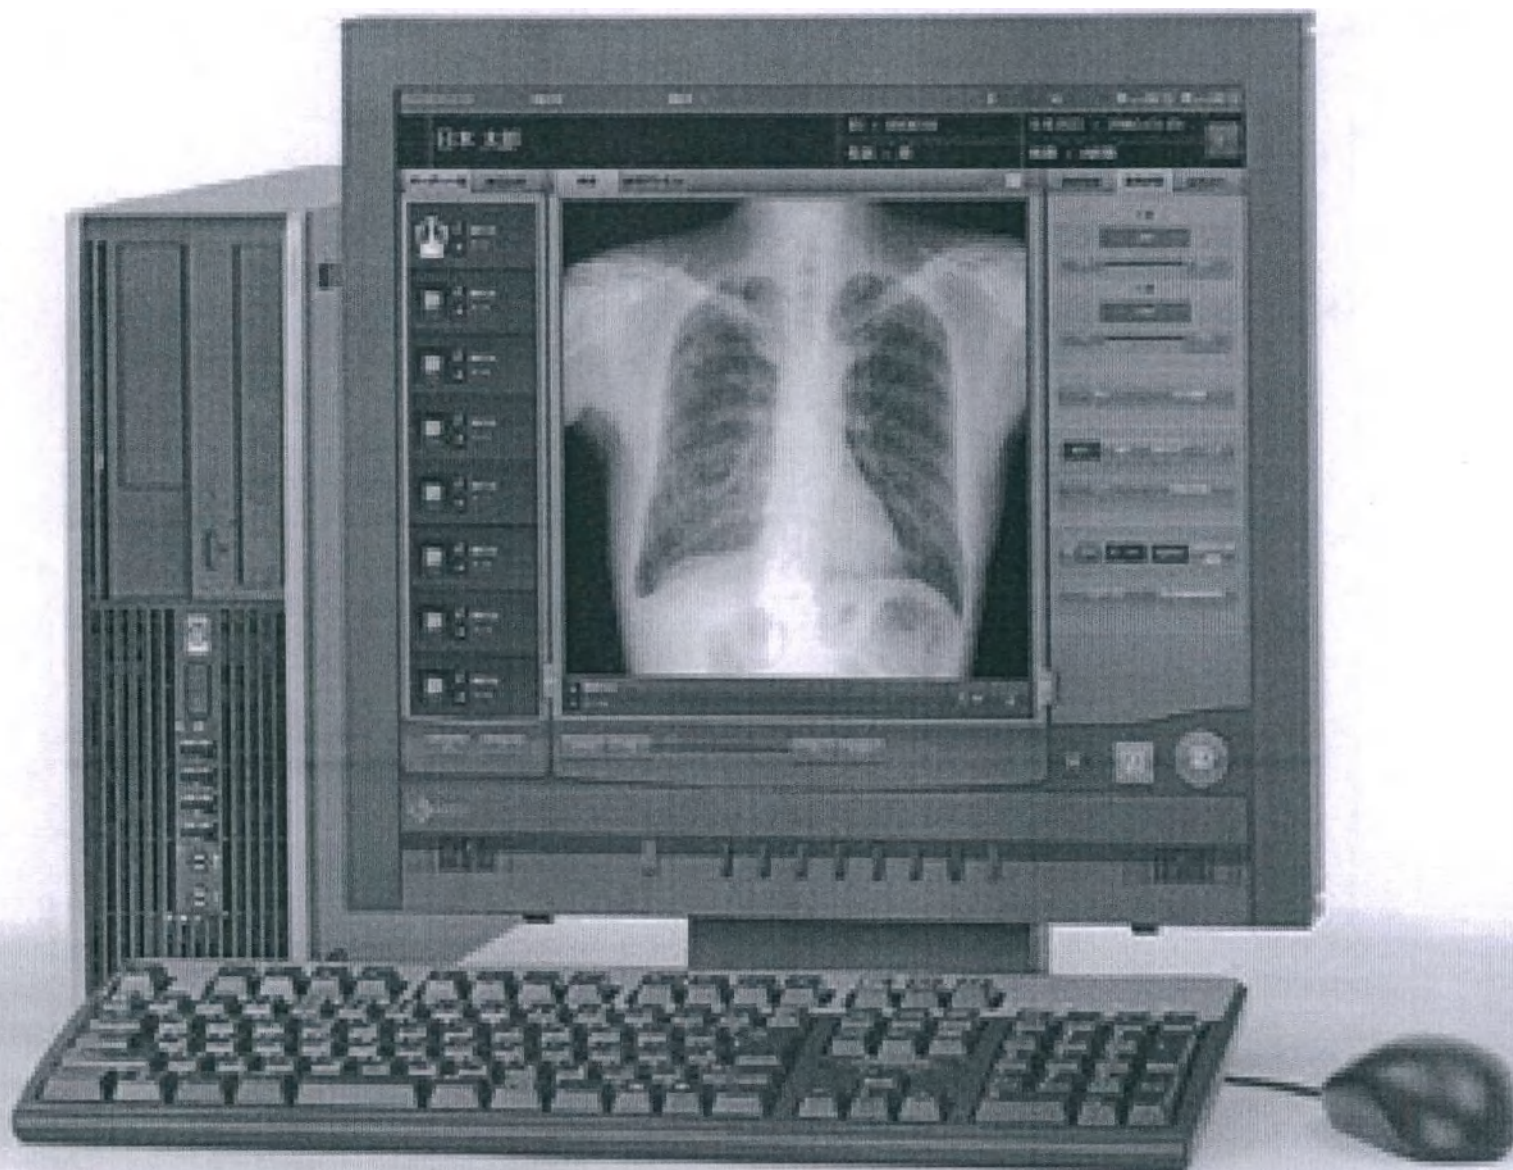


или Nexus DR или DRF производства Varex Imaging Corporation, США;

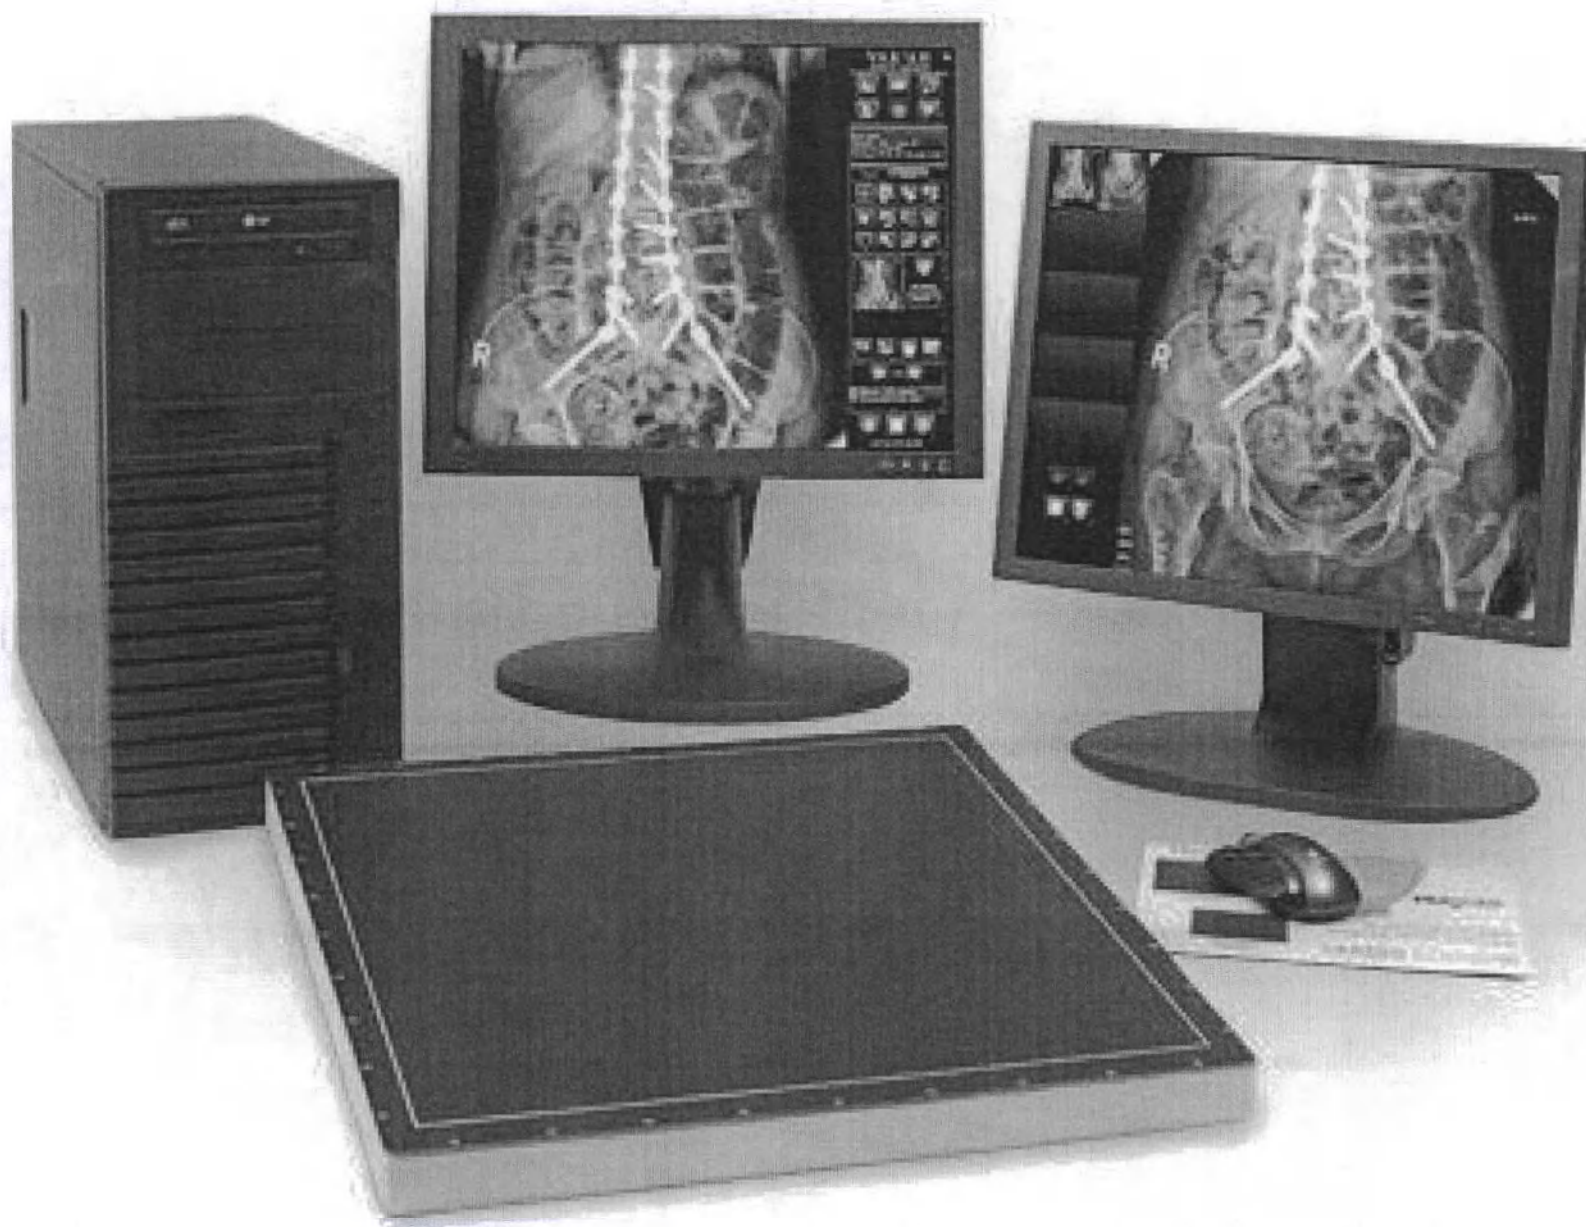


или серии ECONSULE1, производства DRTECH, Республика Корея;

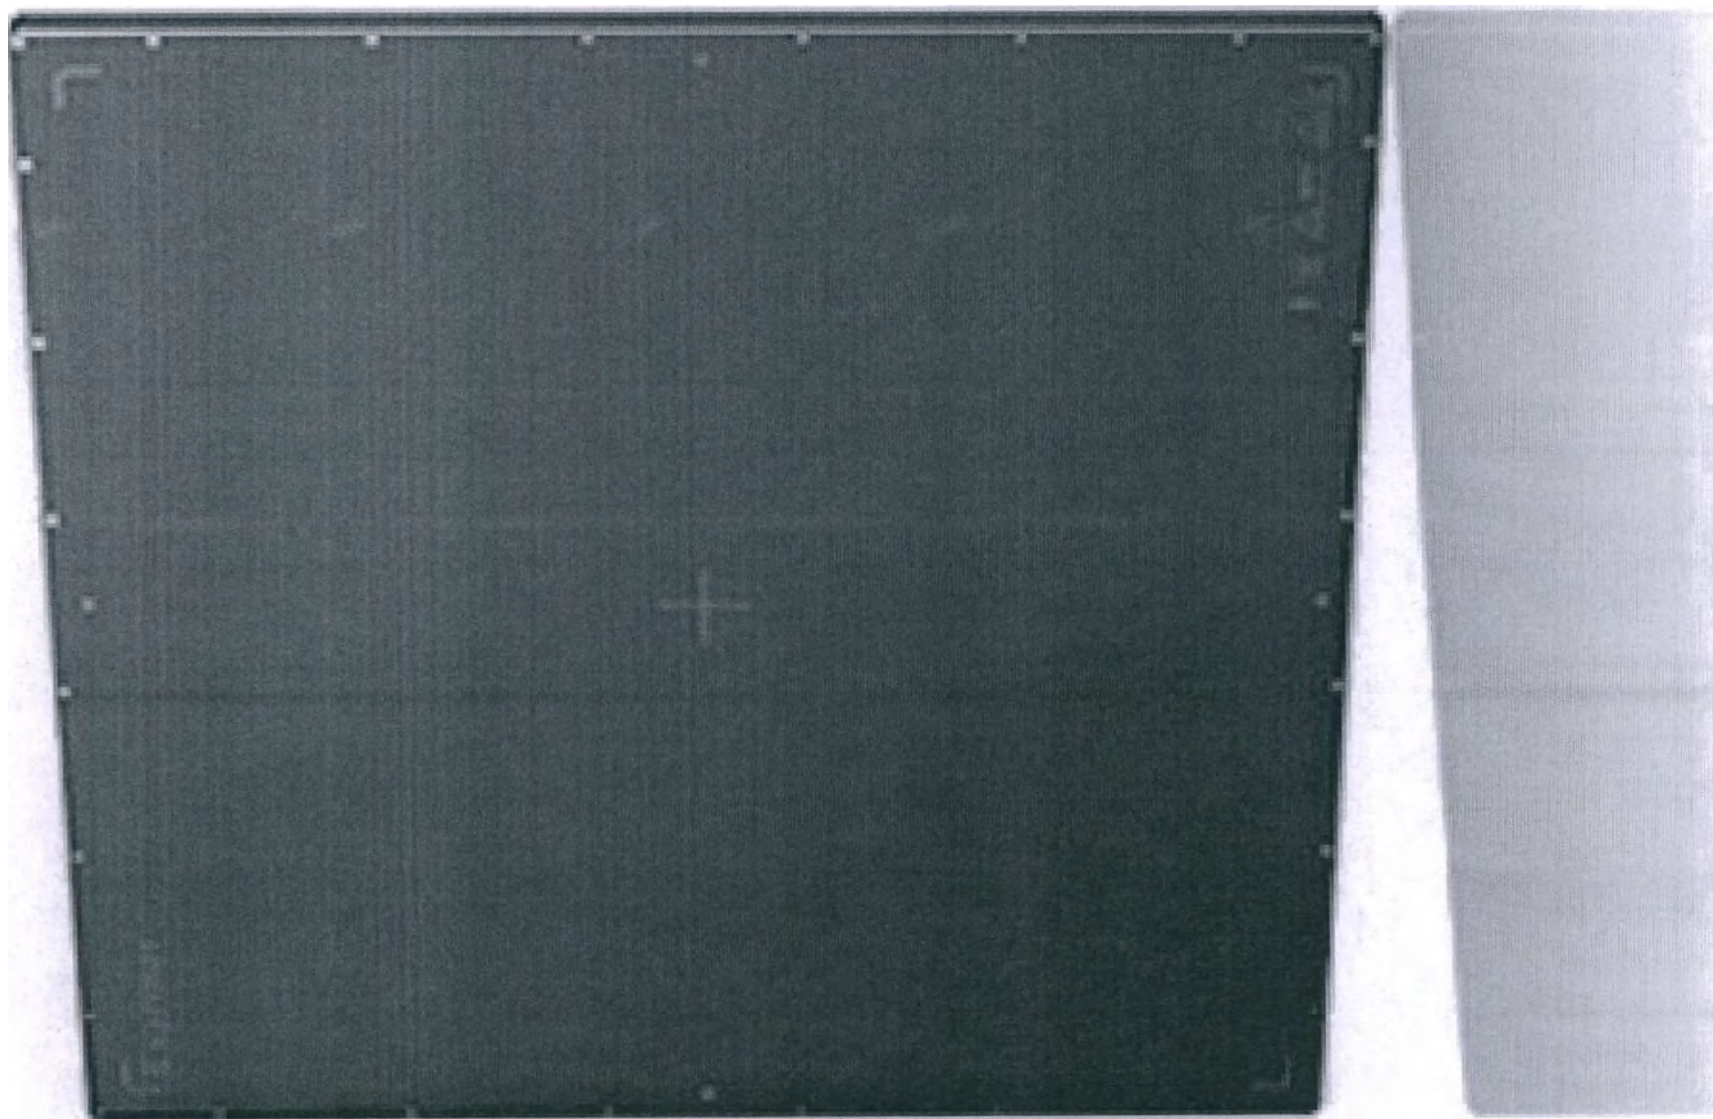


или производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

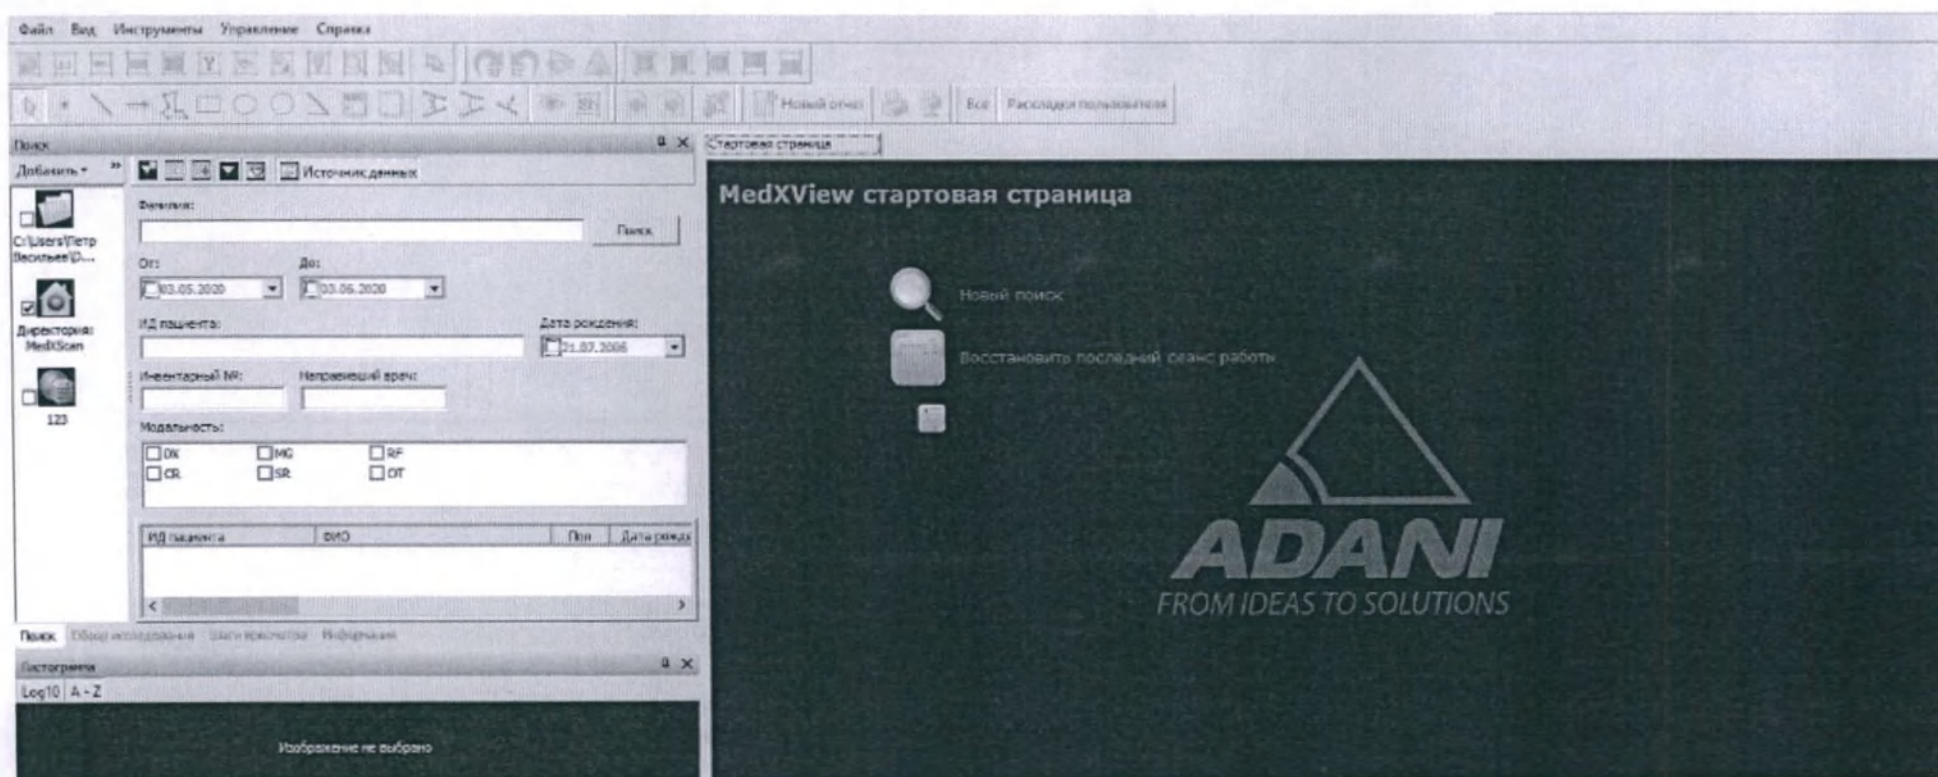


17. Цифровой детектор Pixium производства Thales Electron Devices SAS, Франция;

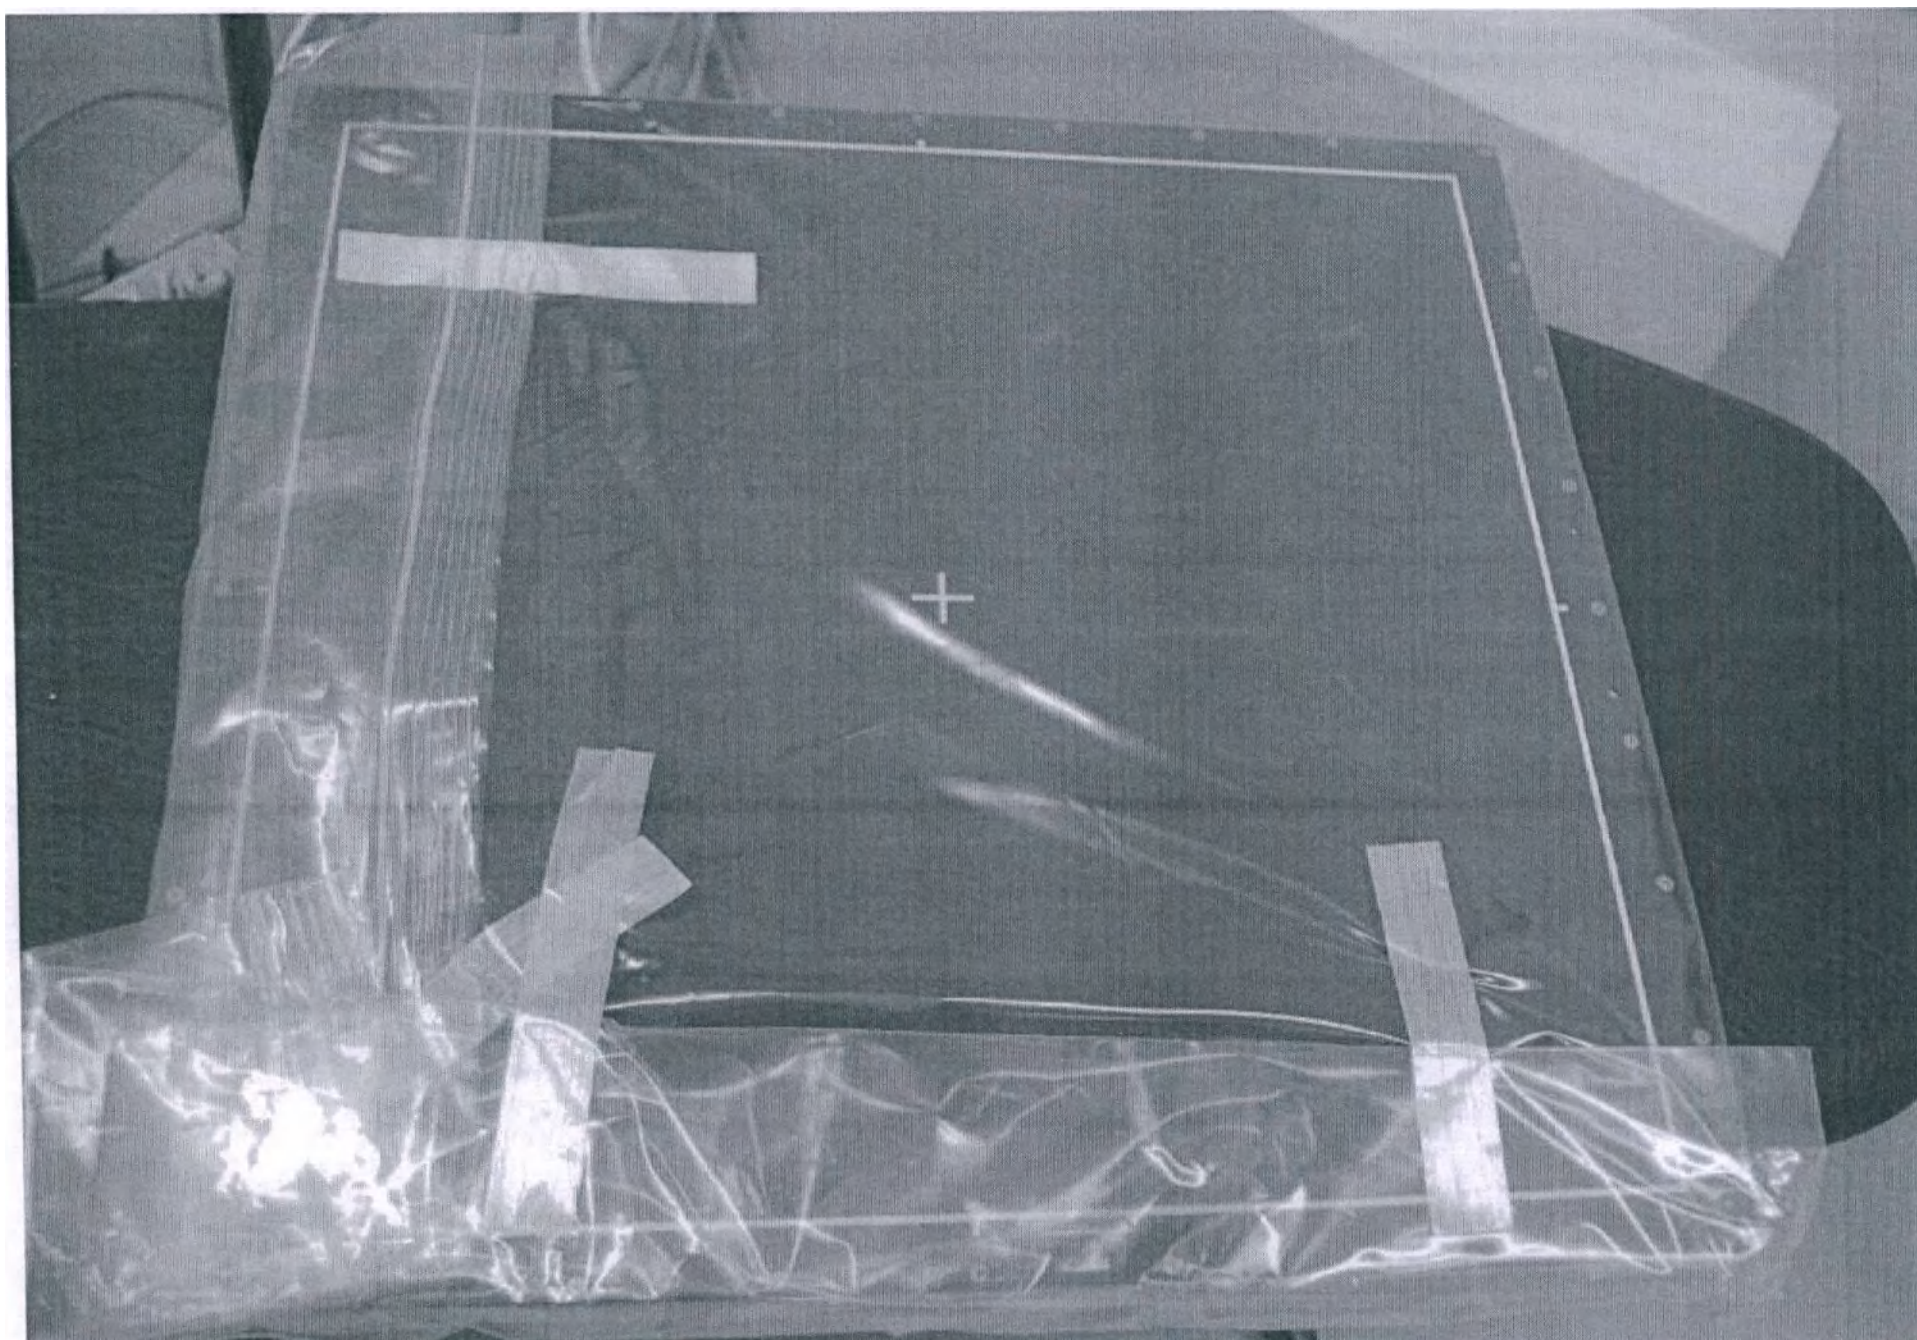


или цифровой приёмник изображения PaxScan или XRpad производства Varex Imaging Corporation, США;

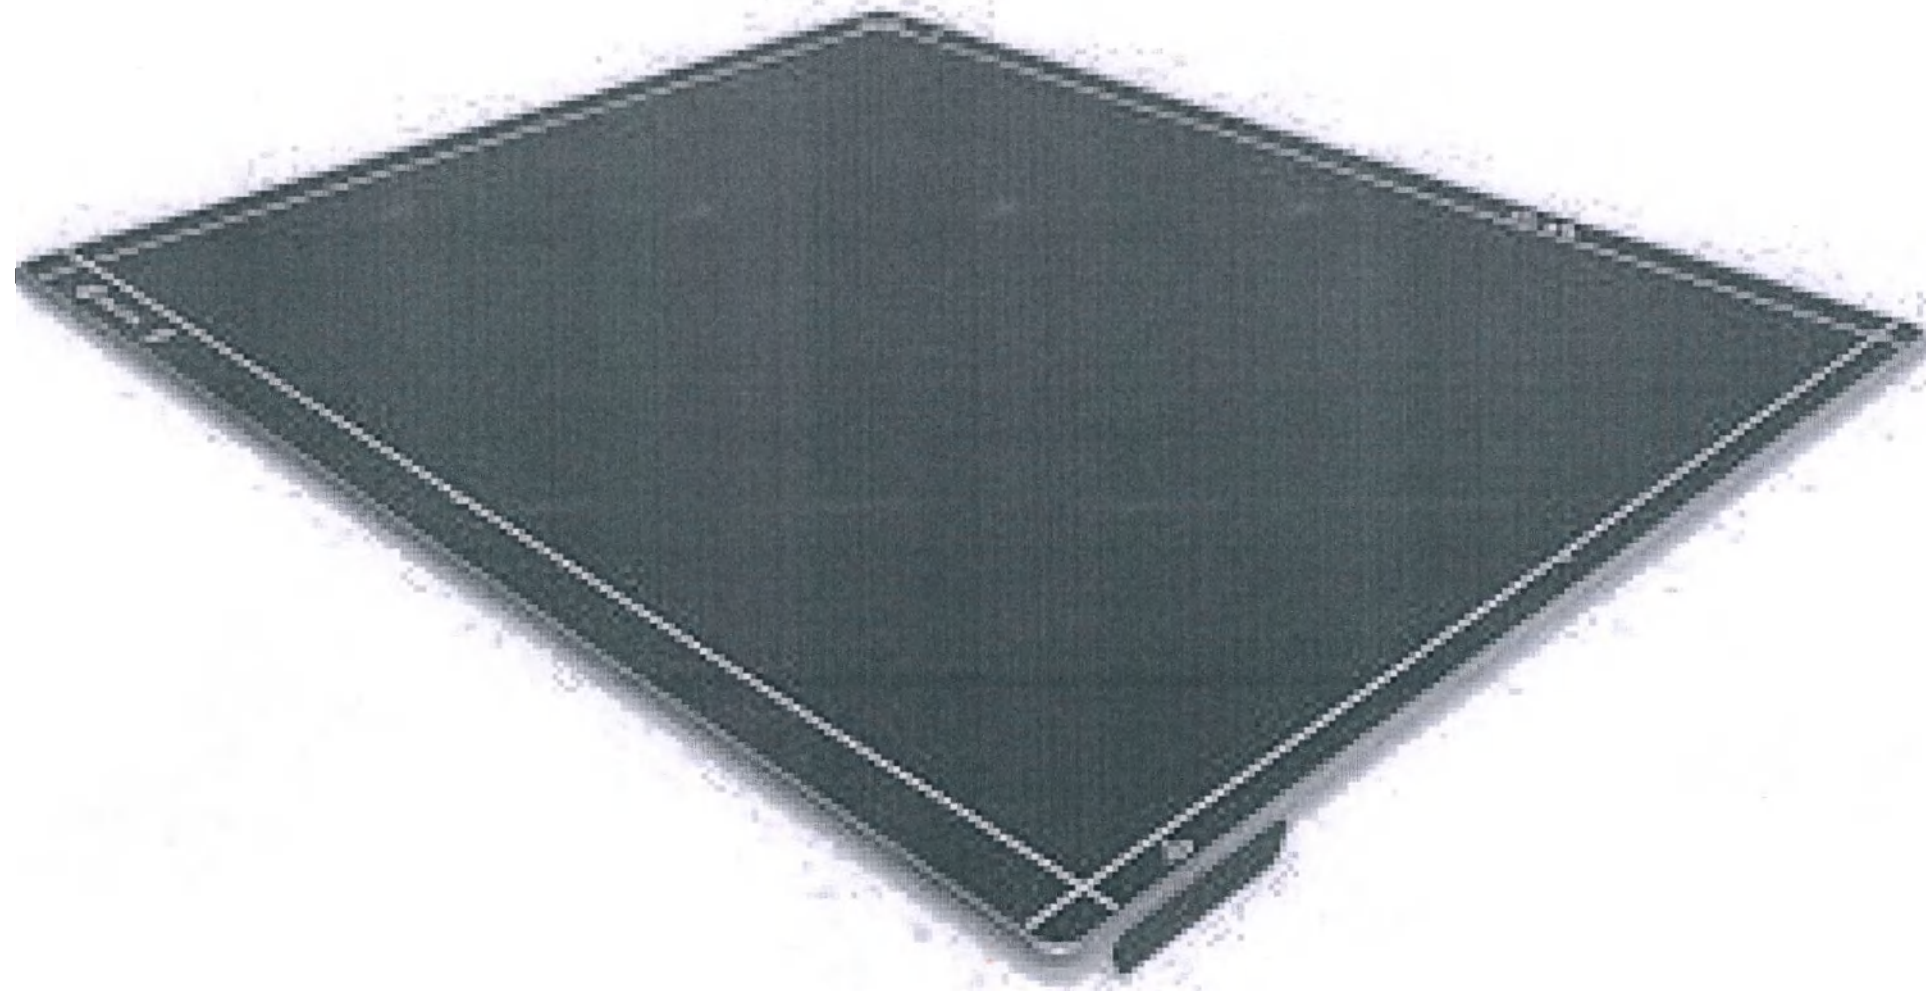

или система цифровой радиологии медицинская диагностическая на основе беспроводного детектора рентгеновского излучения DRX производства Carestream Health Inc., США (РУ № ФСЗ 2012/13085);

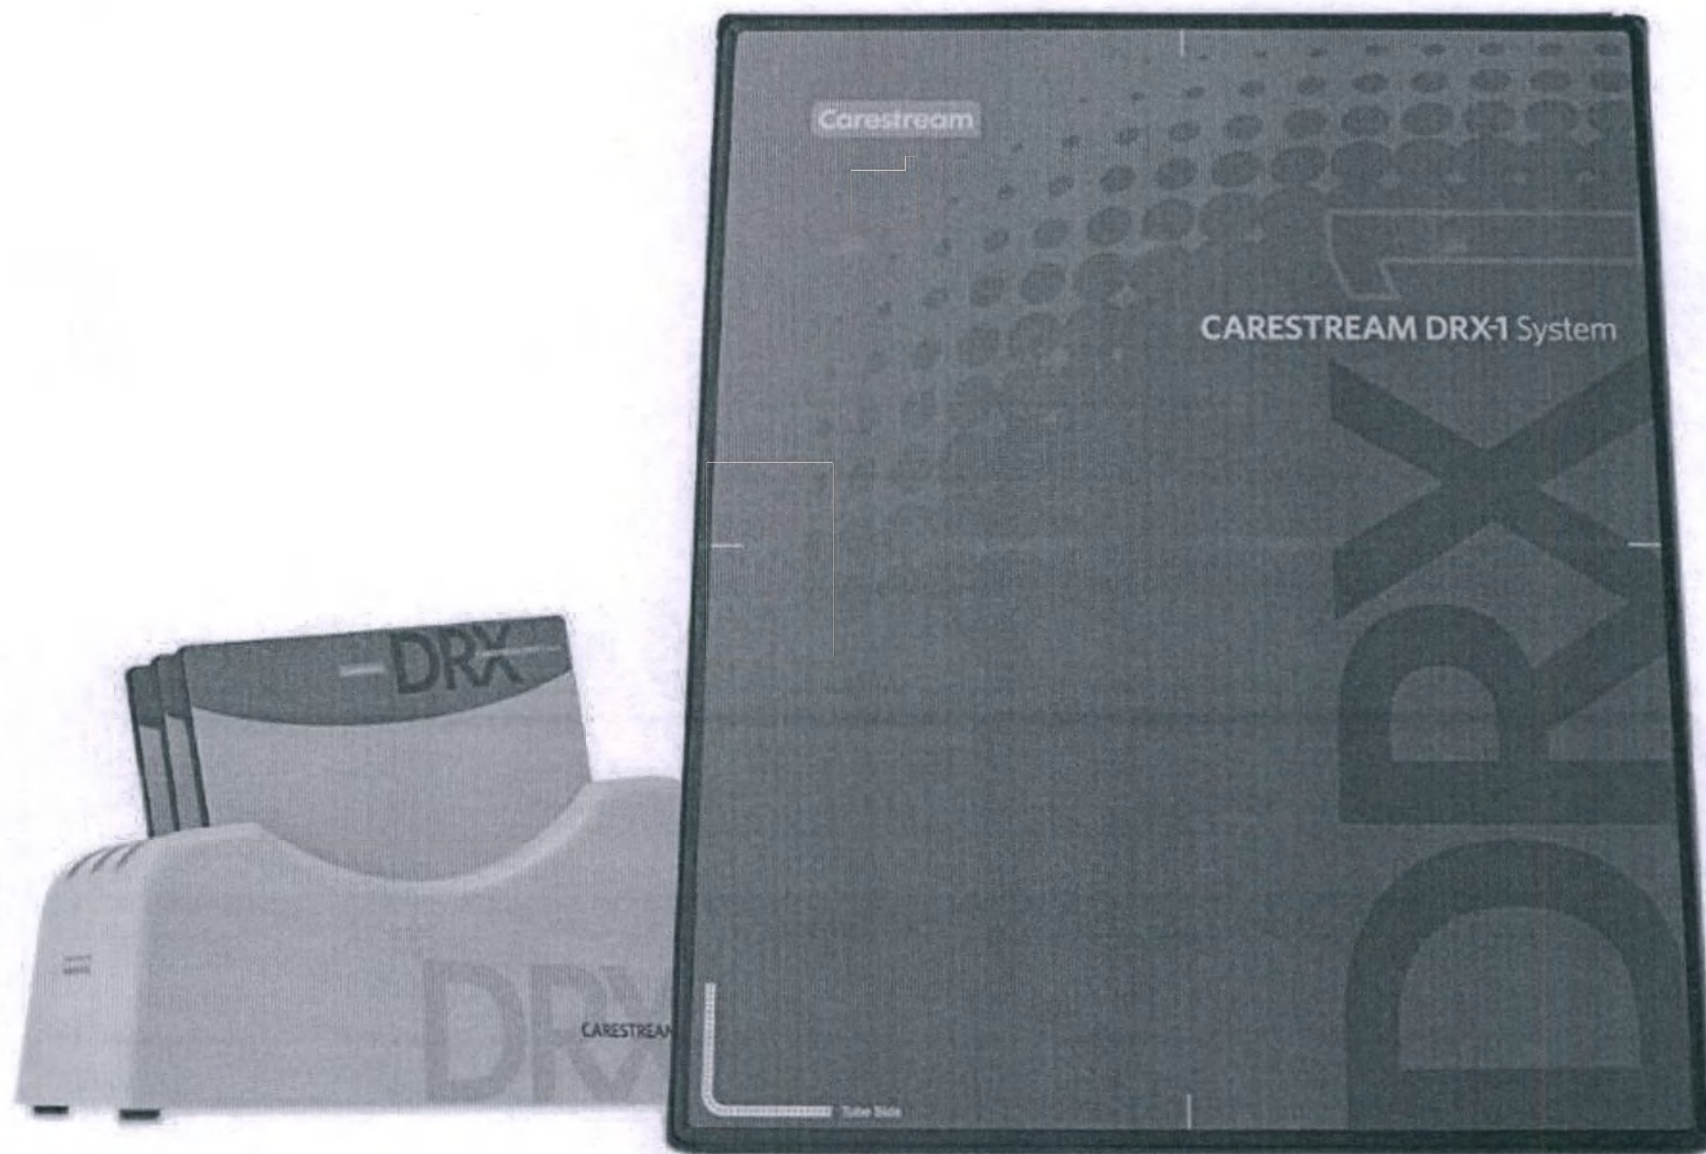


или приёмник рентгенографический цифровой ViVIX-S производства Vieworks Co., Ltd., Республика Корея;

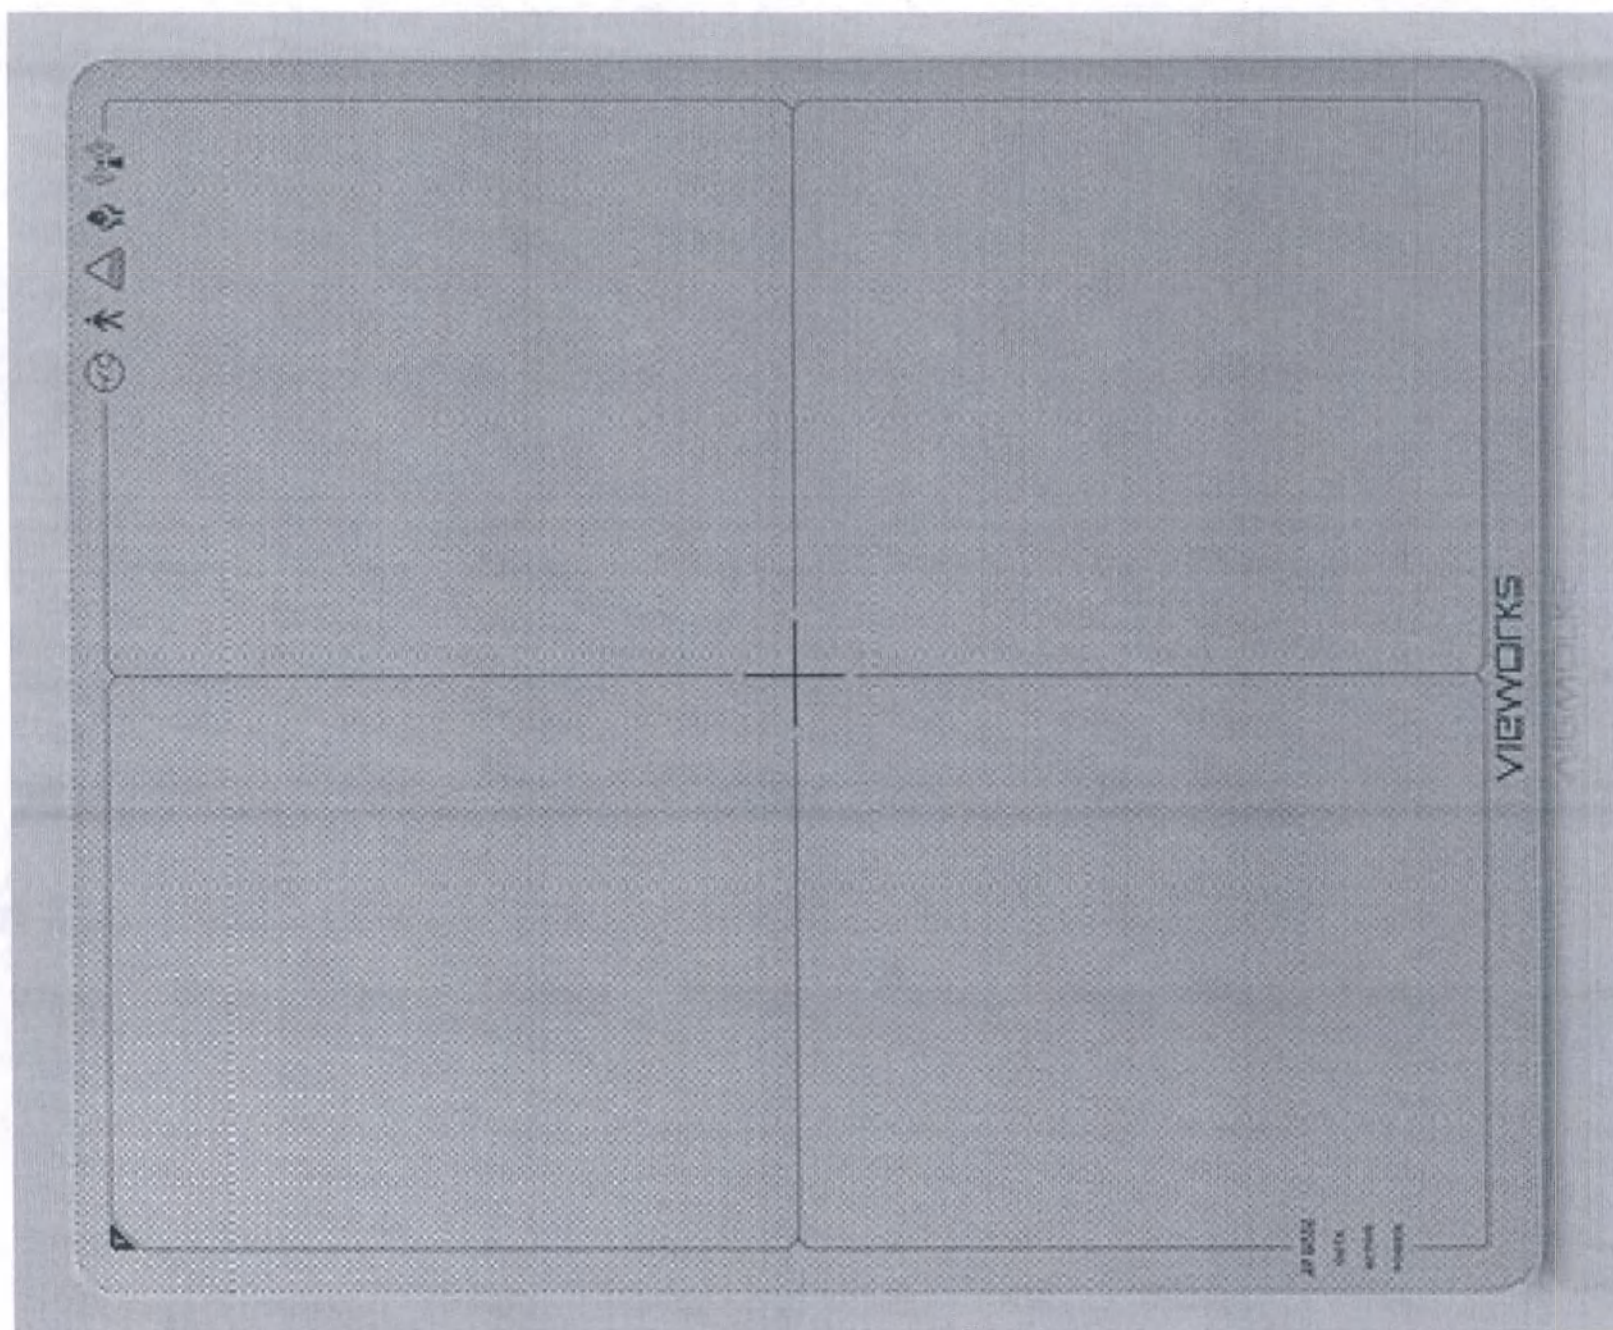


или аппарат цифровой радиологии АэроДР, варианты исполнения: Р-31, Р-51, Р-52 производства Konica Minolta, Inc., Япония (РУ № РЗН 2018/7682);




или EVS производства DRTECH, Республика Корея;

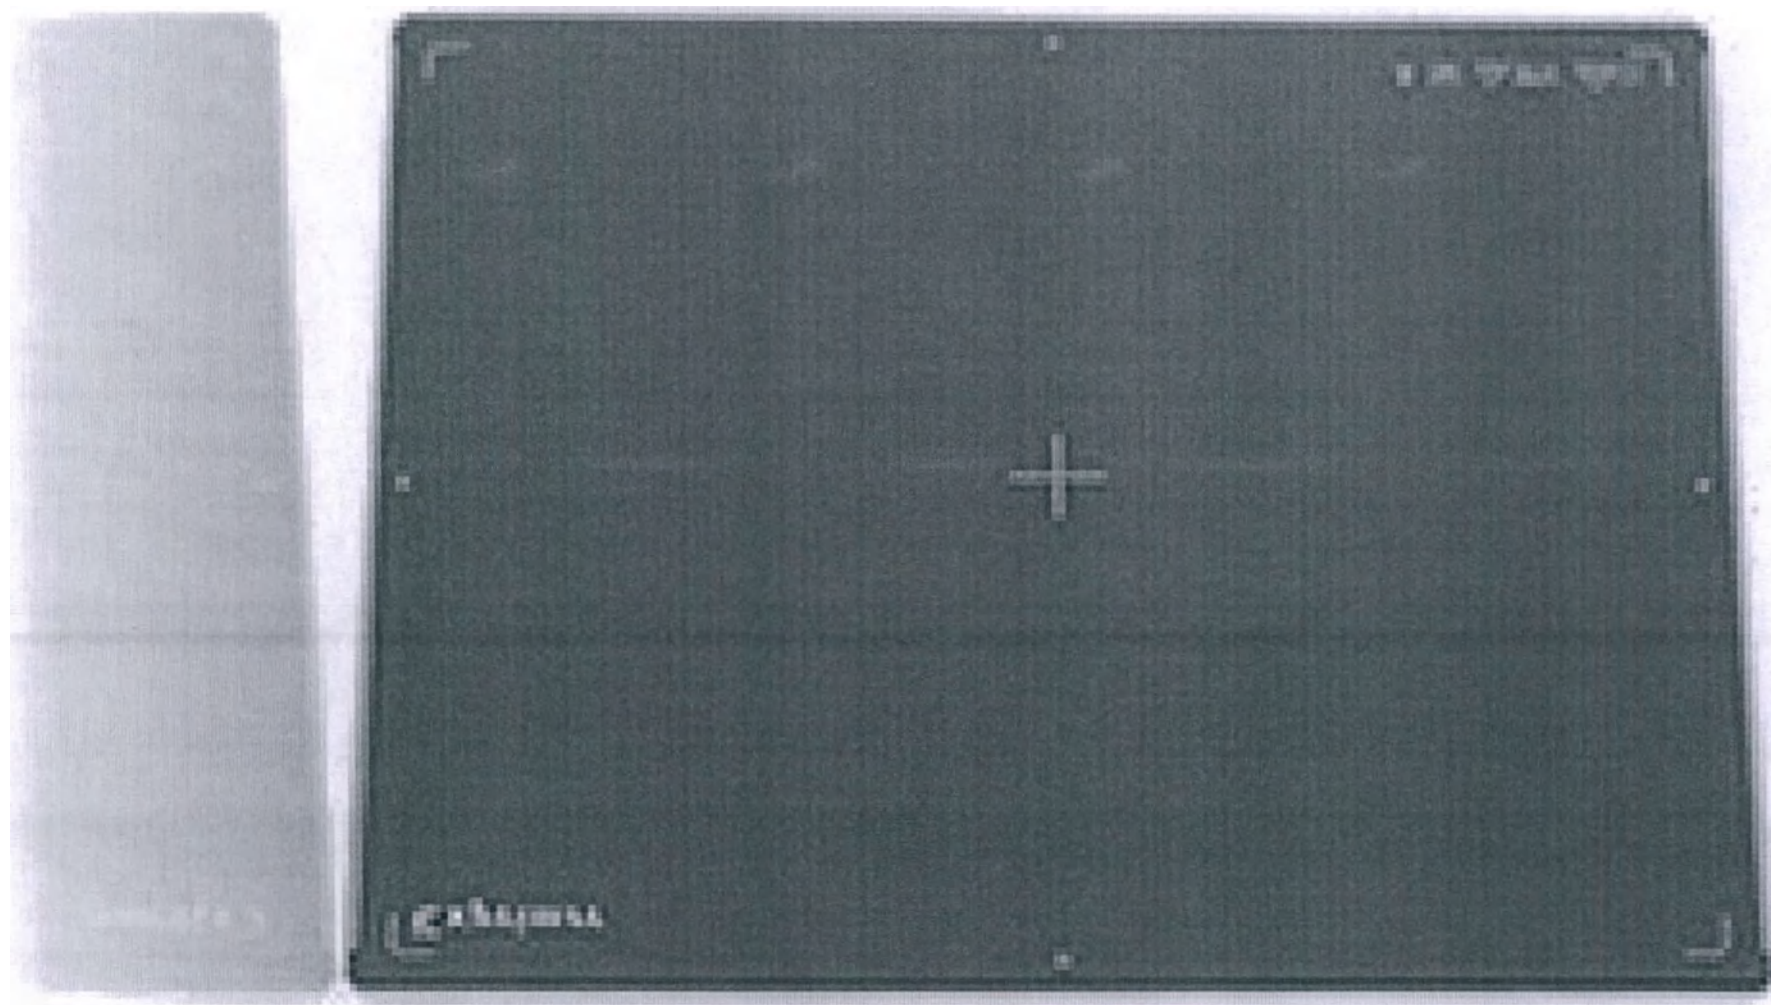


или Mars, Venu производства iRay Technology Co Ltd., Китай;

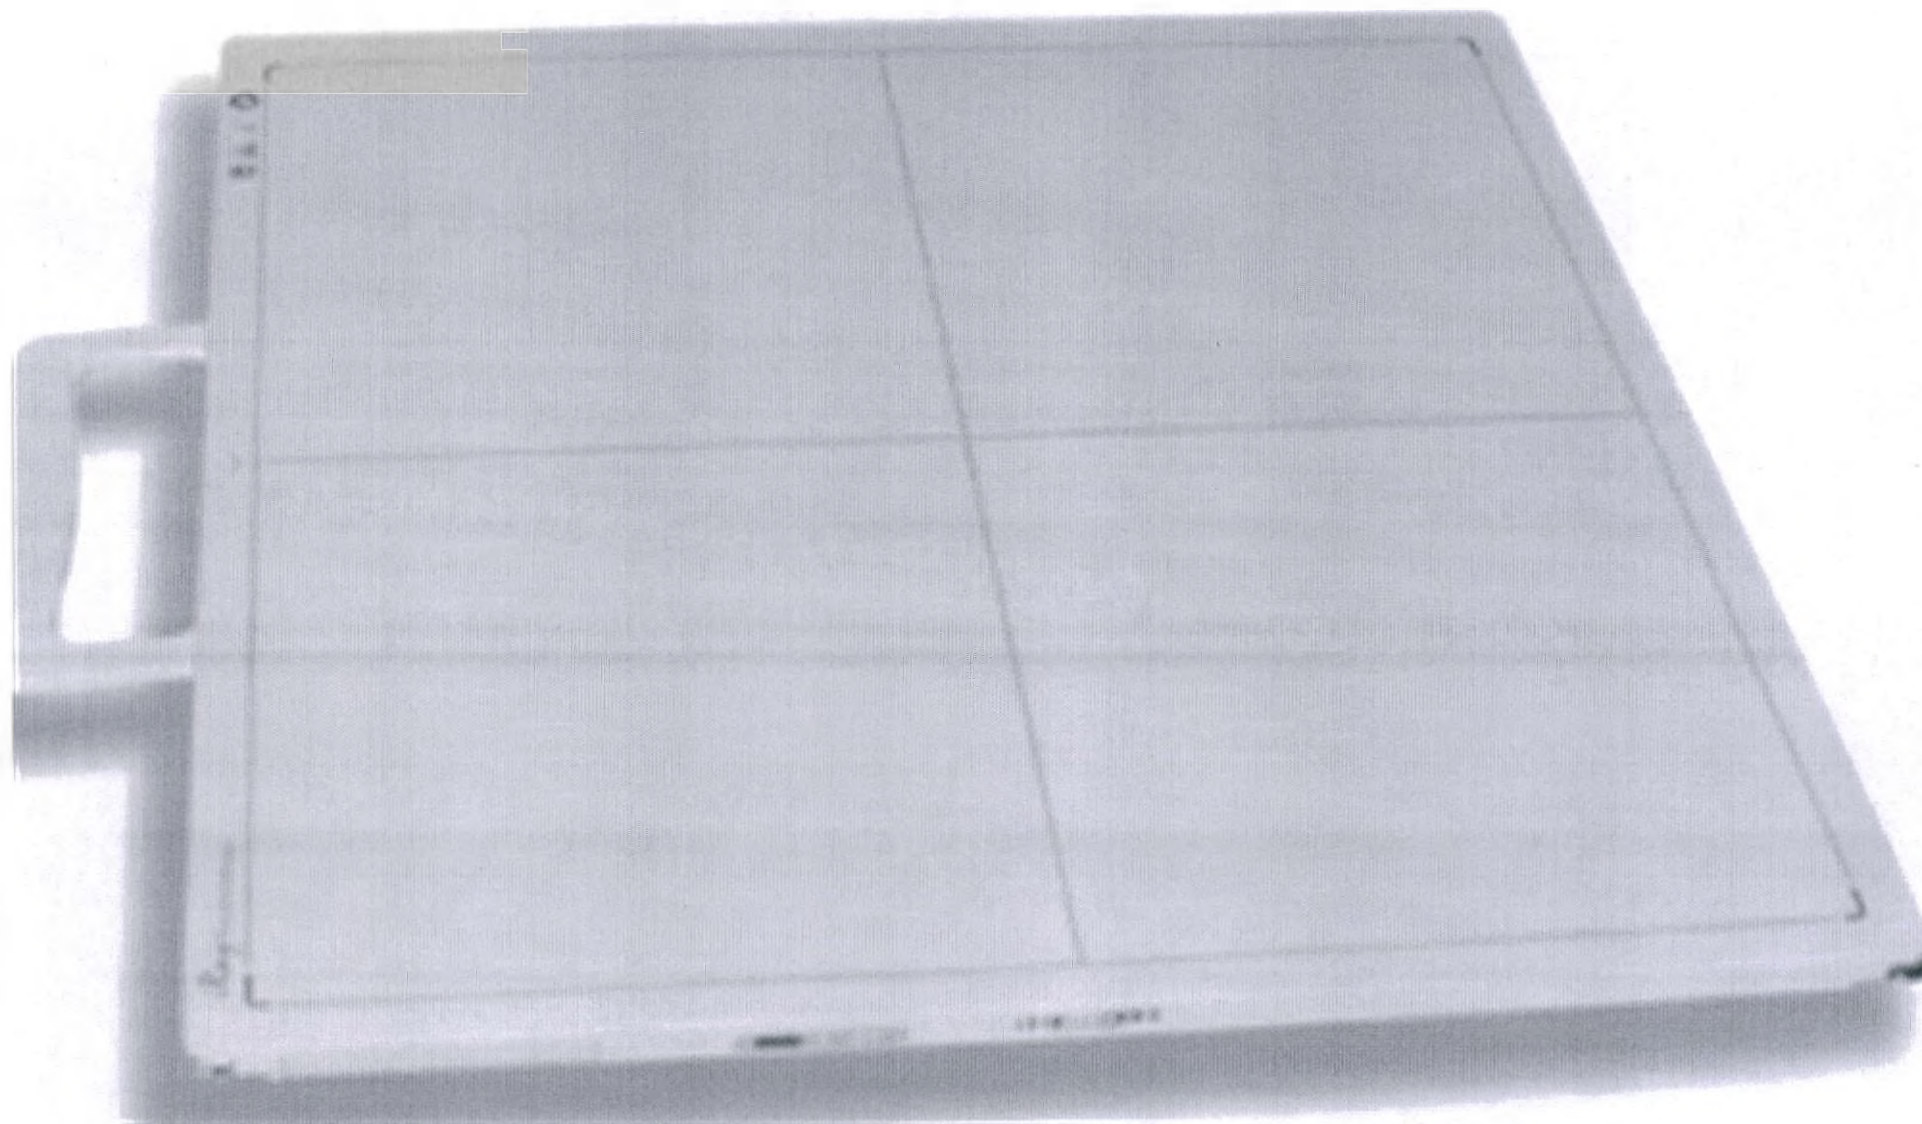


или CareView производства Care Ray Medical System Co, Китай;

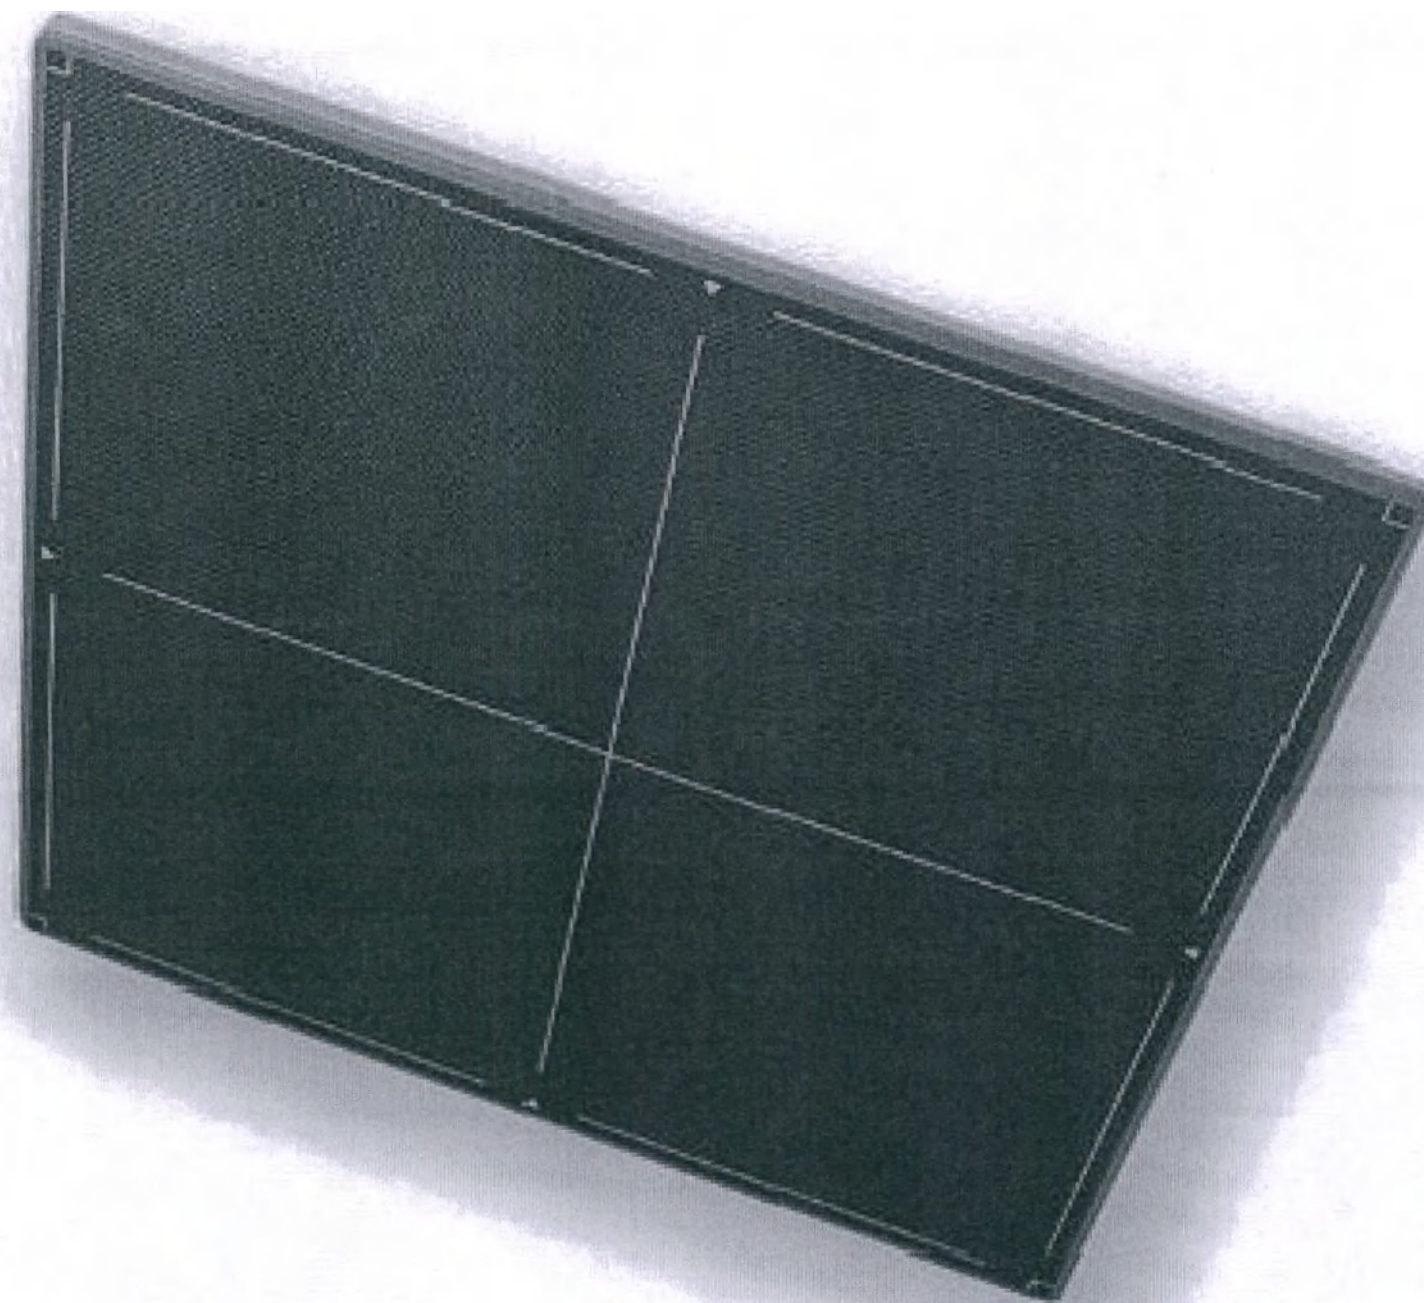

или CXDI производства Canon Medical System Corporation, Япония.

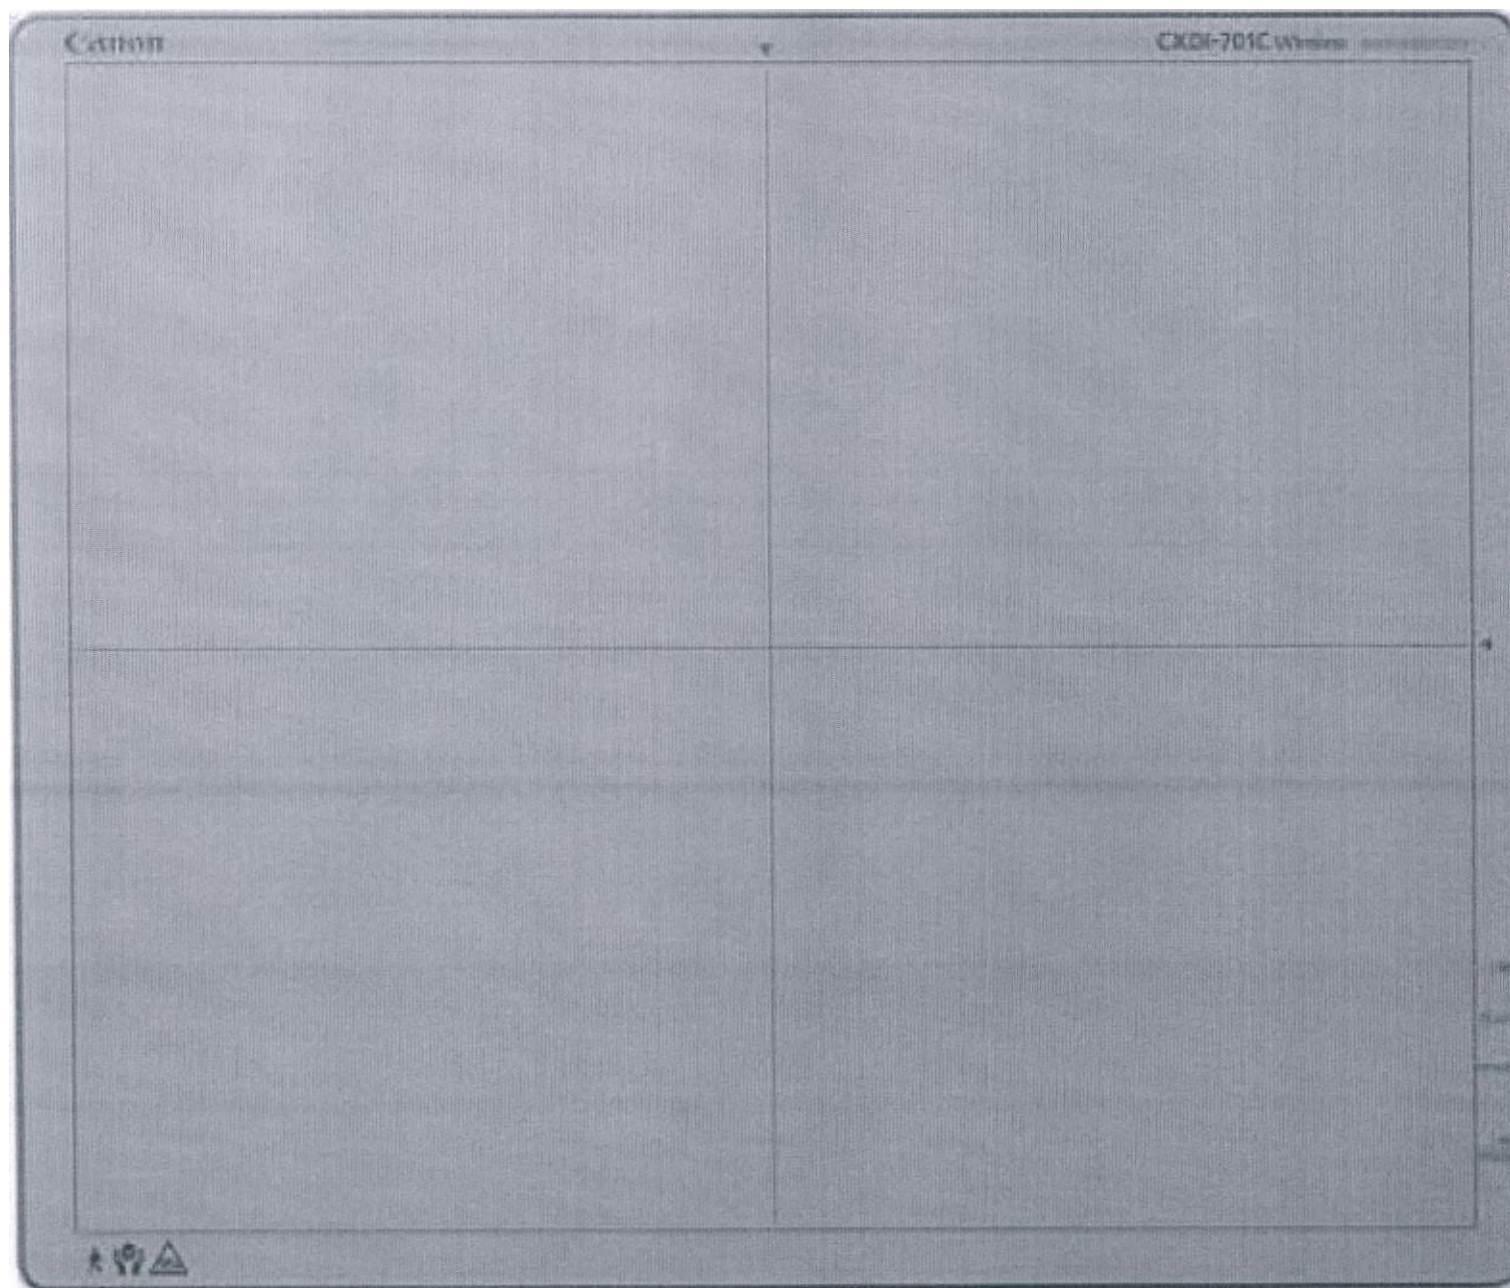


18. Программное обеспечение архива производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь; или программное обеспечение, специализированное «АПК АрхиМед» по ТУ 62.01.29-002-98944313-2015 производства ООО «МЕД-РЕЙ», Российская Федерация (РУ № РЗН 2019/8485); или комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 (РУ № РЗН 2017/5621) или комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по ТУ 9442-233-38226244-2015 (РЗН 2017/5616) производства ООО «ЛИНС», Российская Федерация.

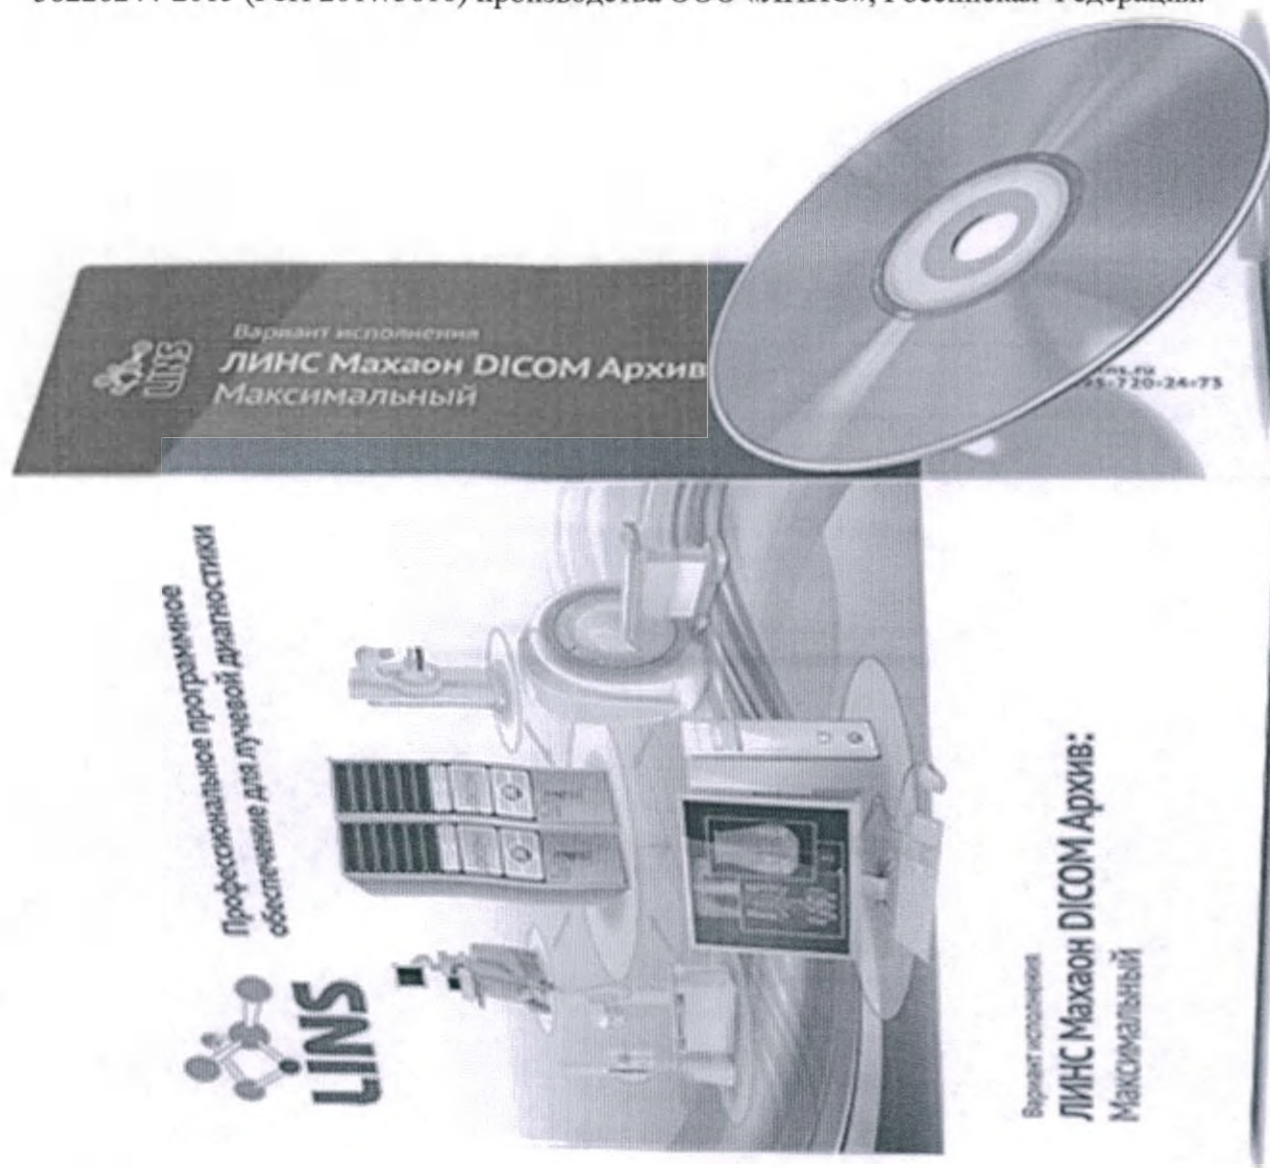

19. Автоматизированное рабочее место (АРМ) производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.




20. Монитор врача CCL; ME; CL; MS; CV; JD производства JVC KENWOOD Corporation, Япония;

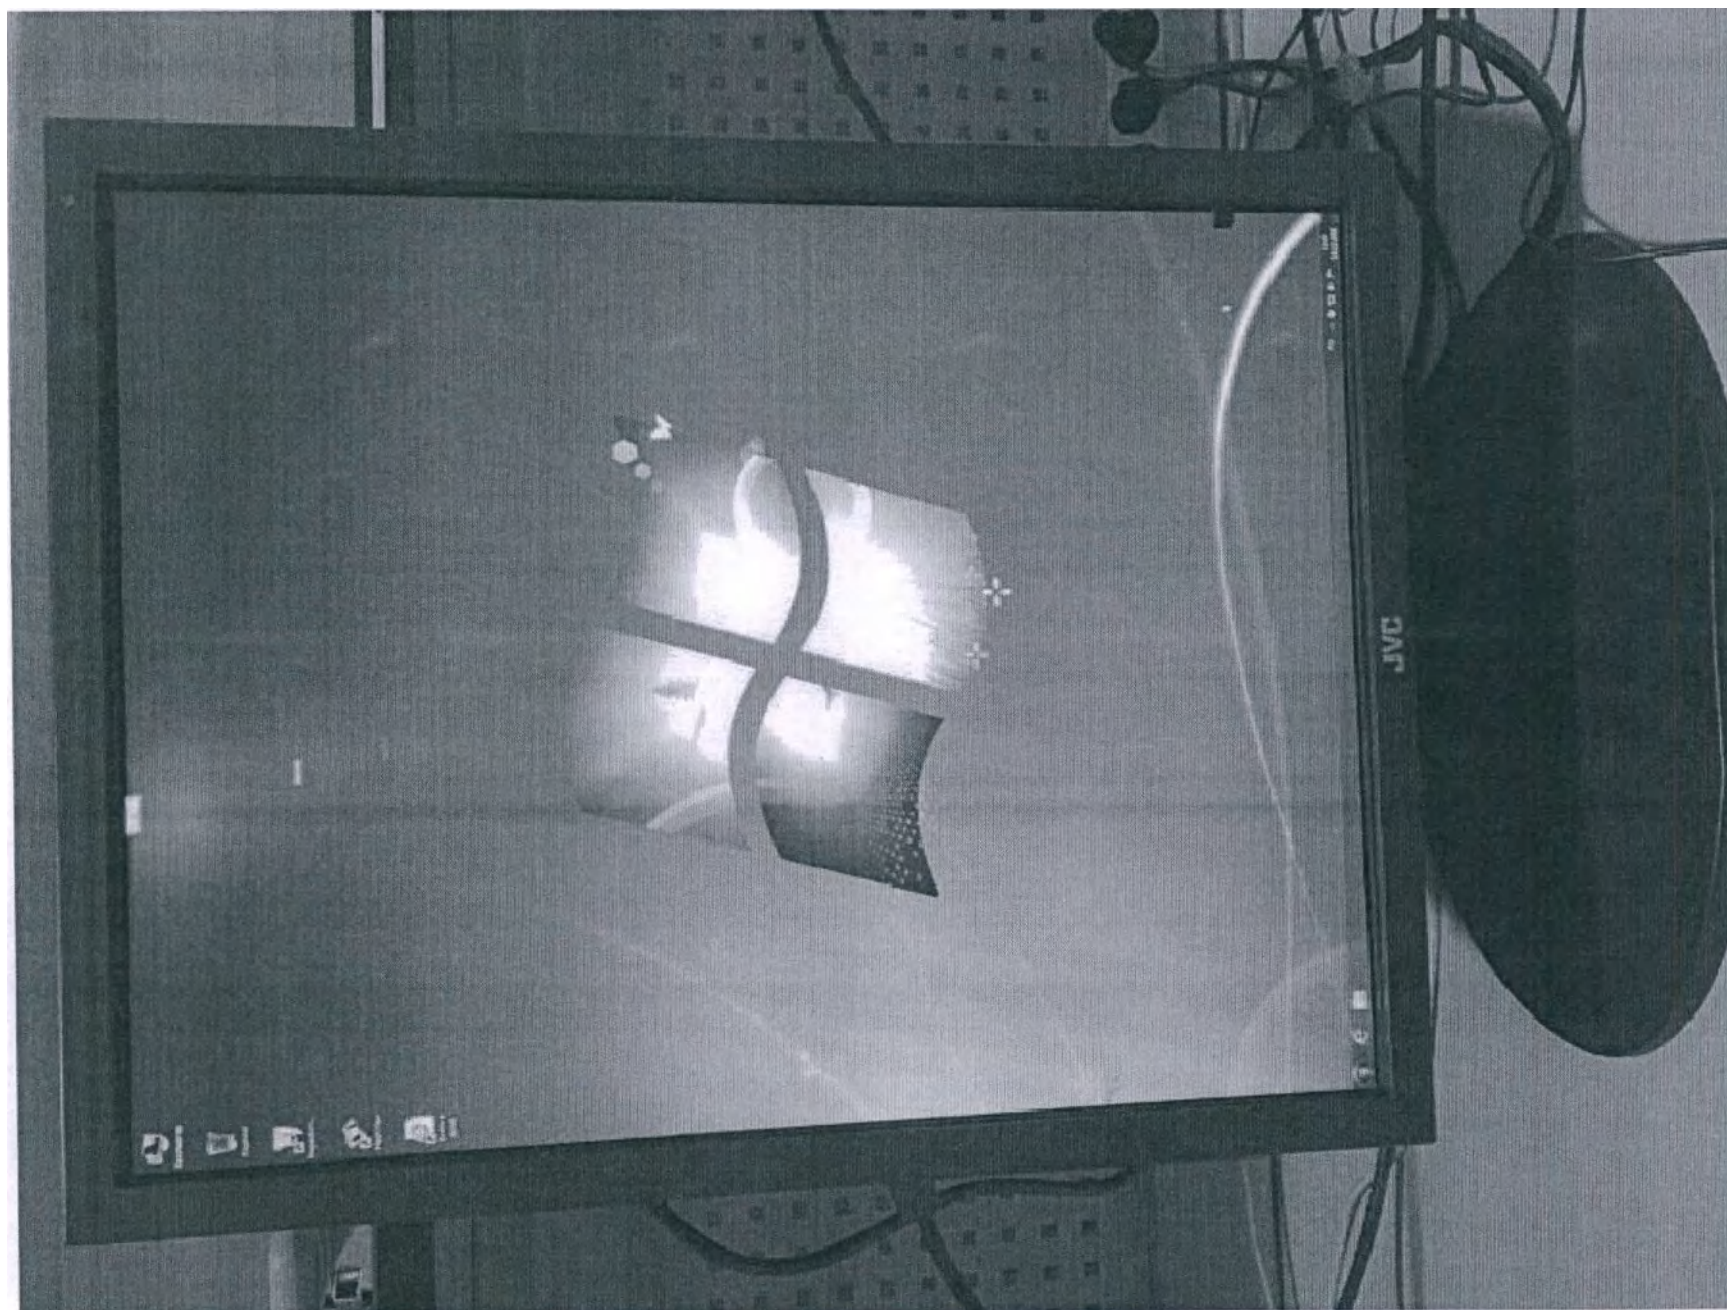

или NDS производства National Display Systems Inc., США;




или NL производства Nical SPA, Италия;

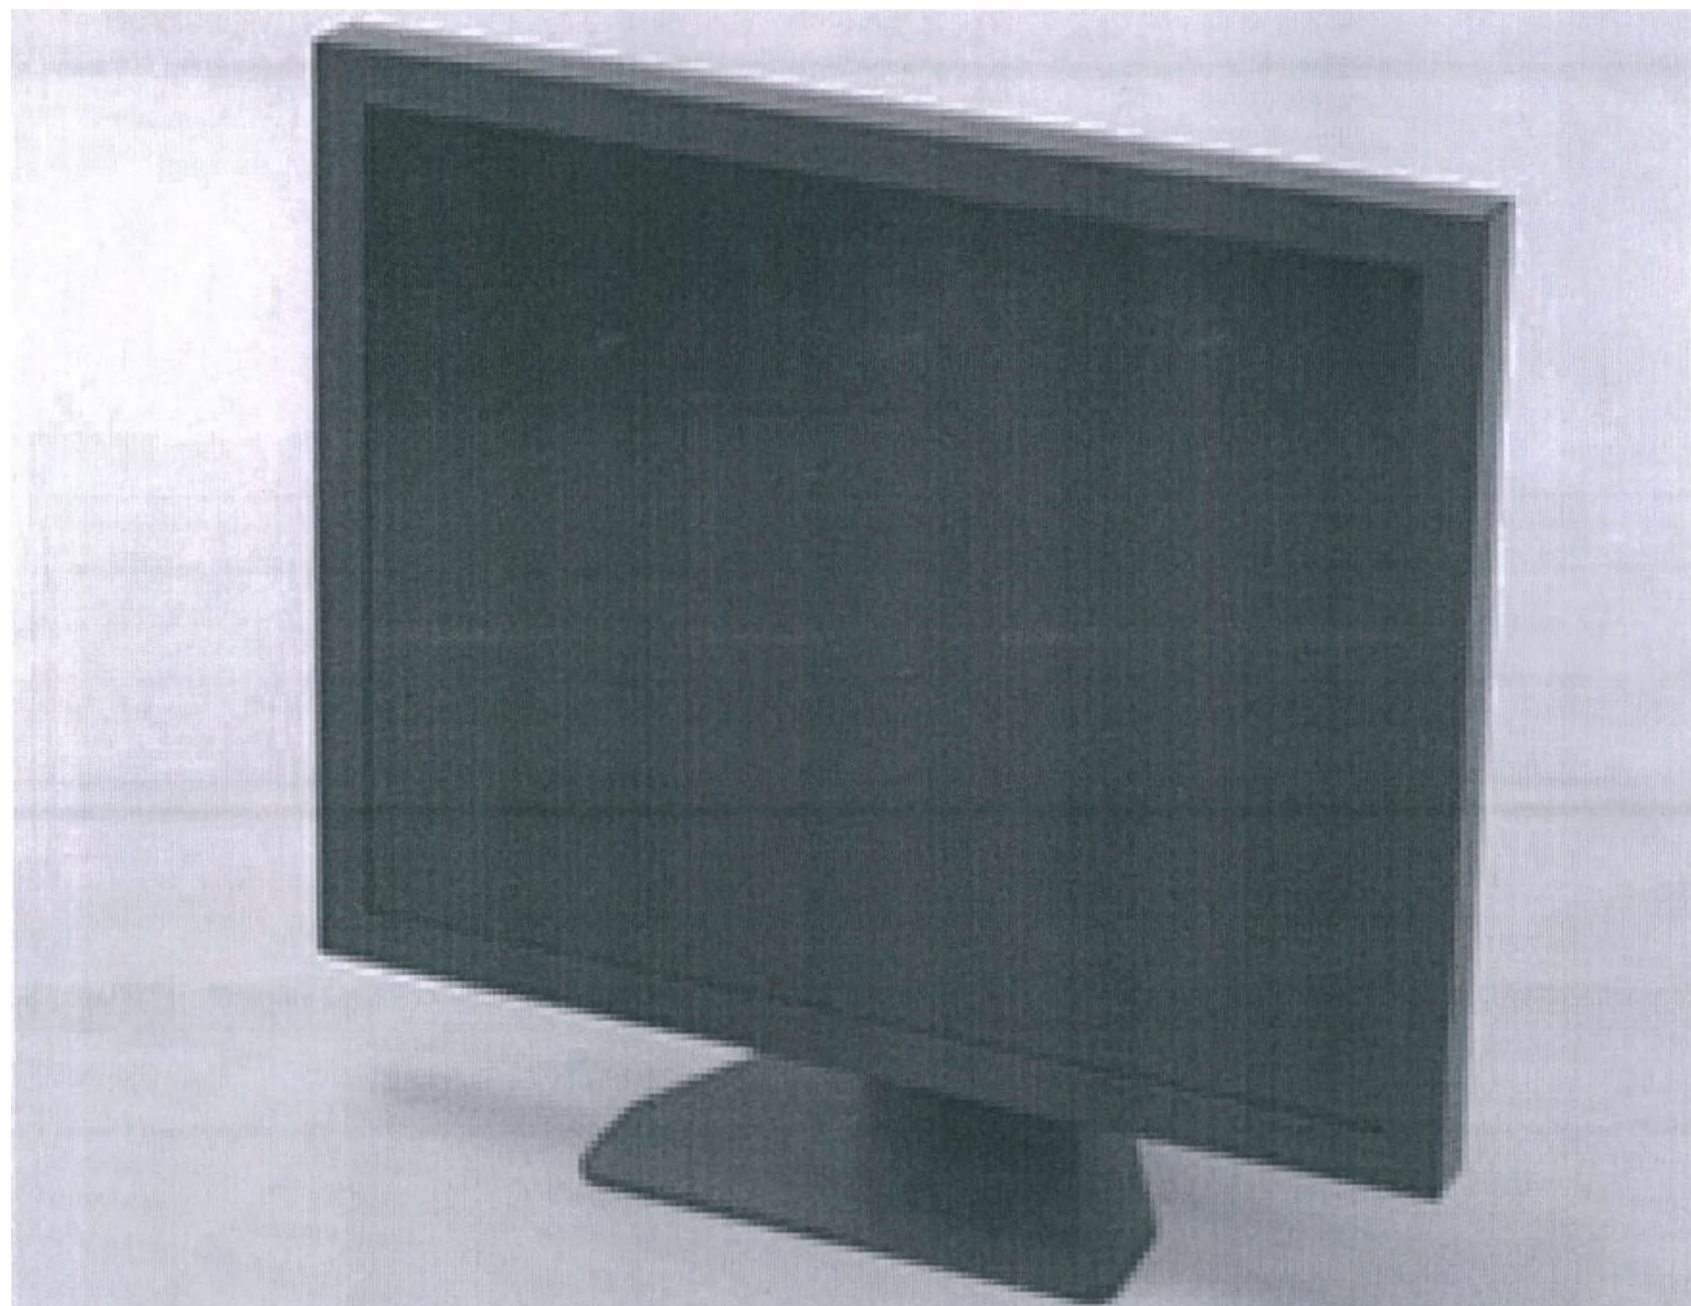


или N, MX, CX, CW производства Wide Corporation, Корея;




или FS; FM; MX производства Foresecon GmbH, Канада;

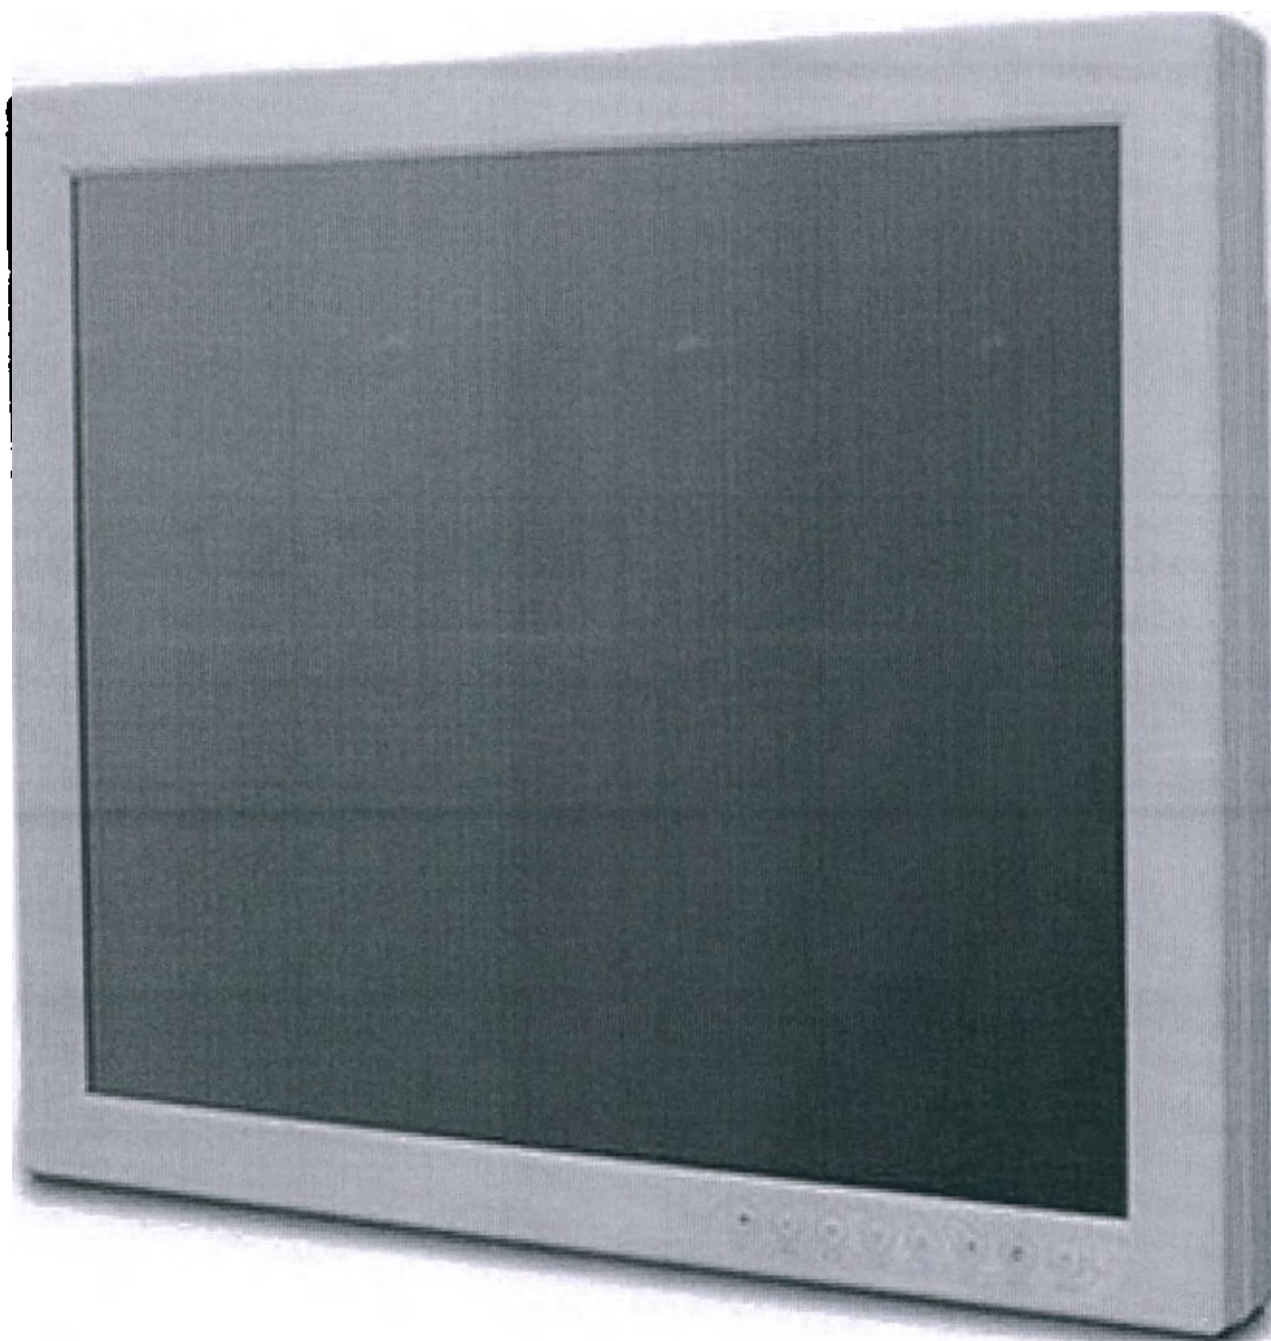


или NEC производства NEC Display Solutions, Япония;

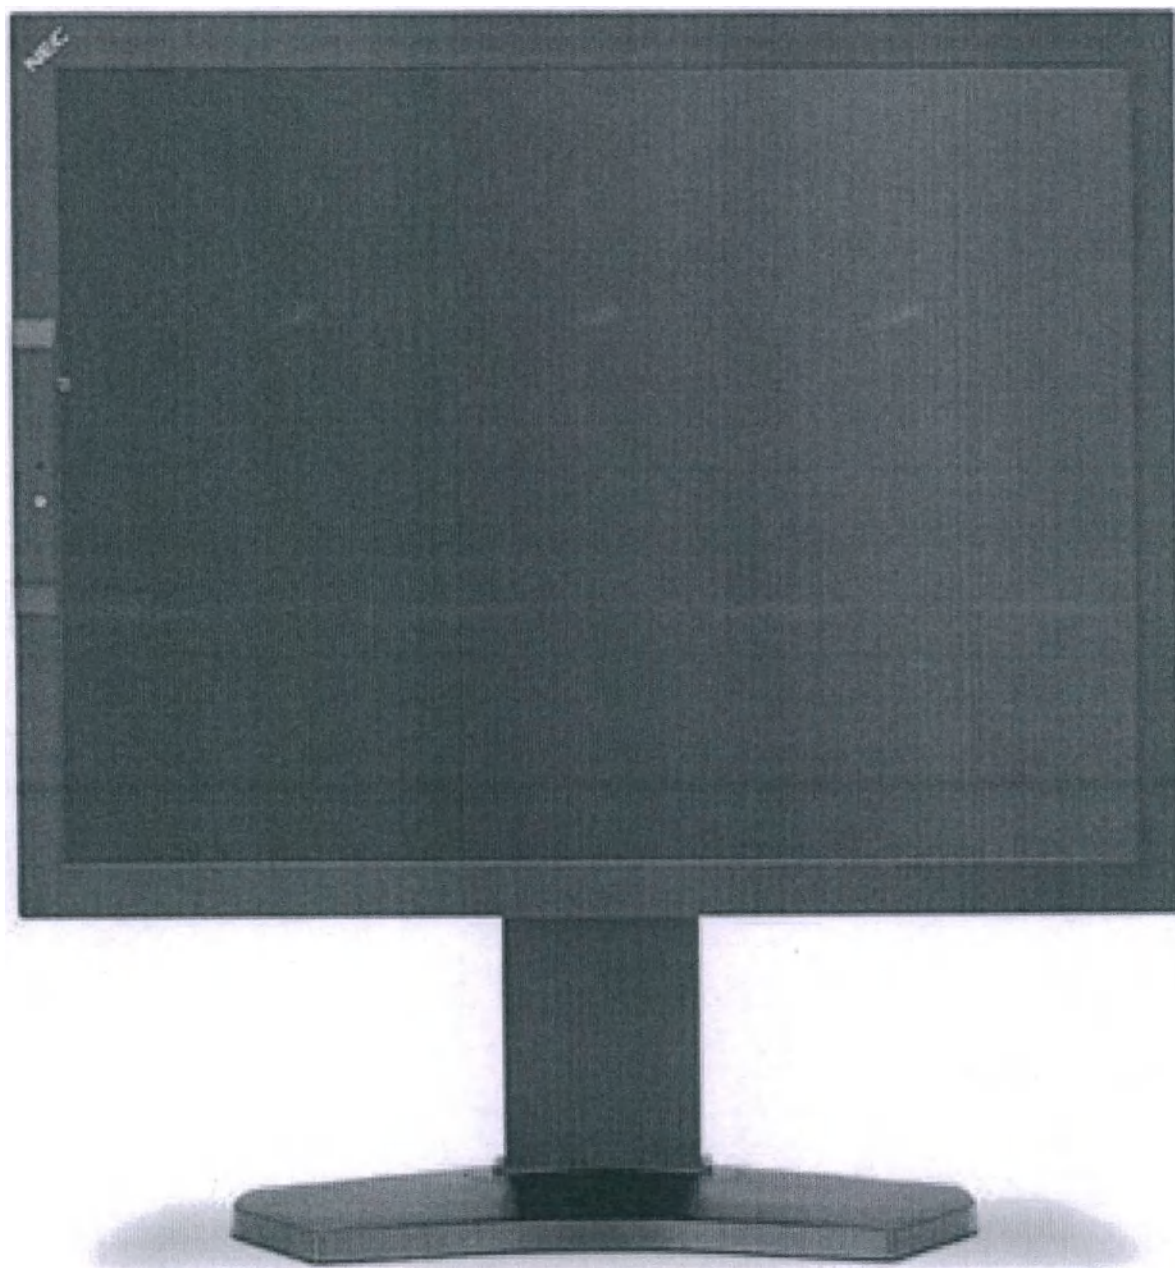

или G, С производства Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай;

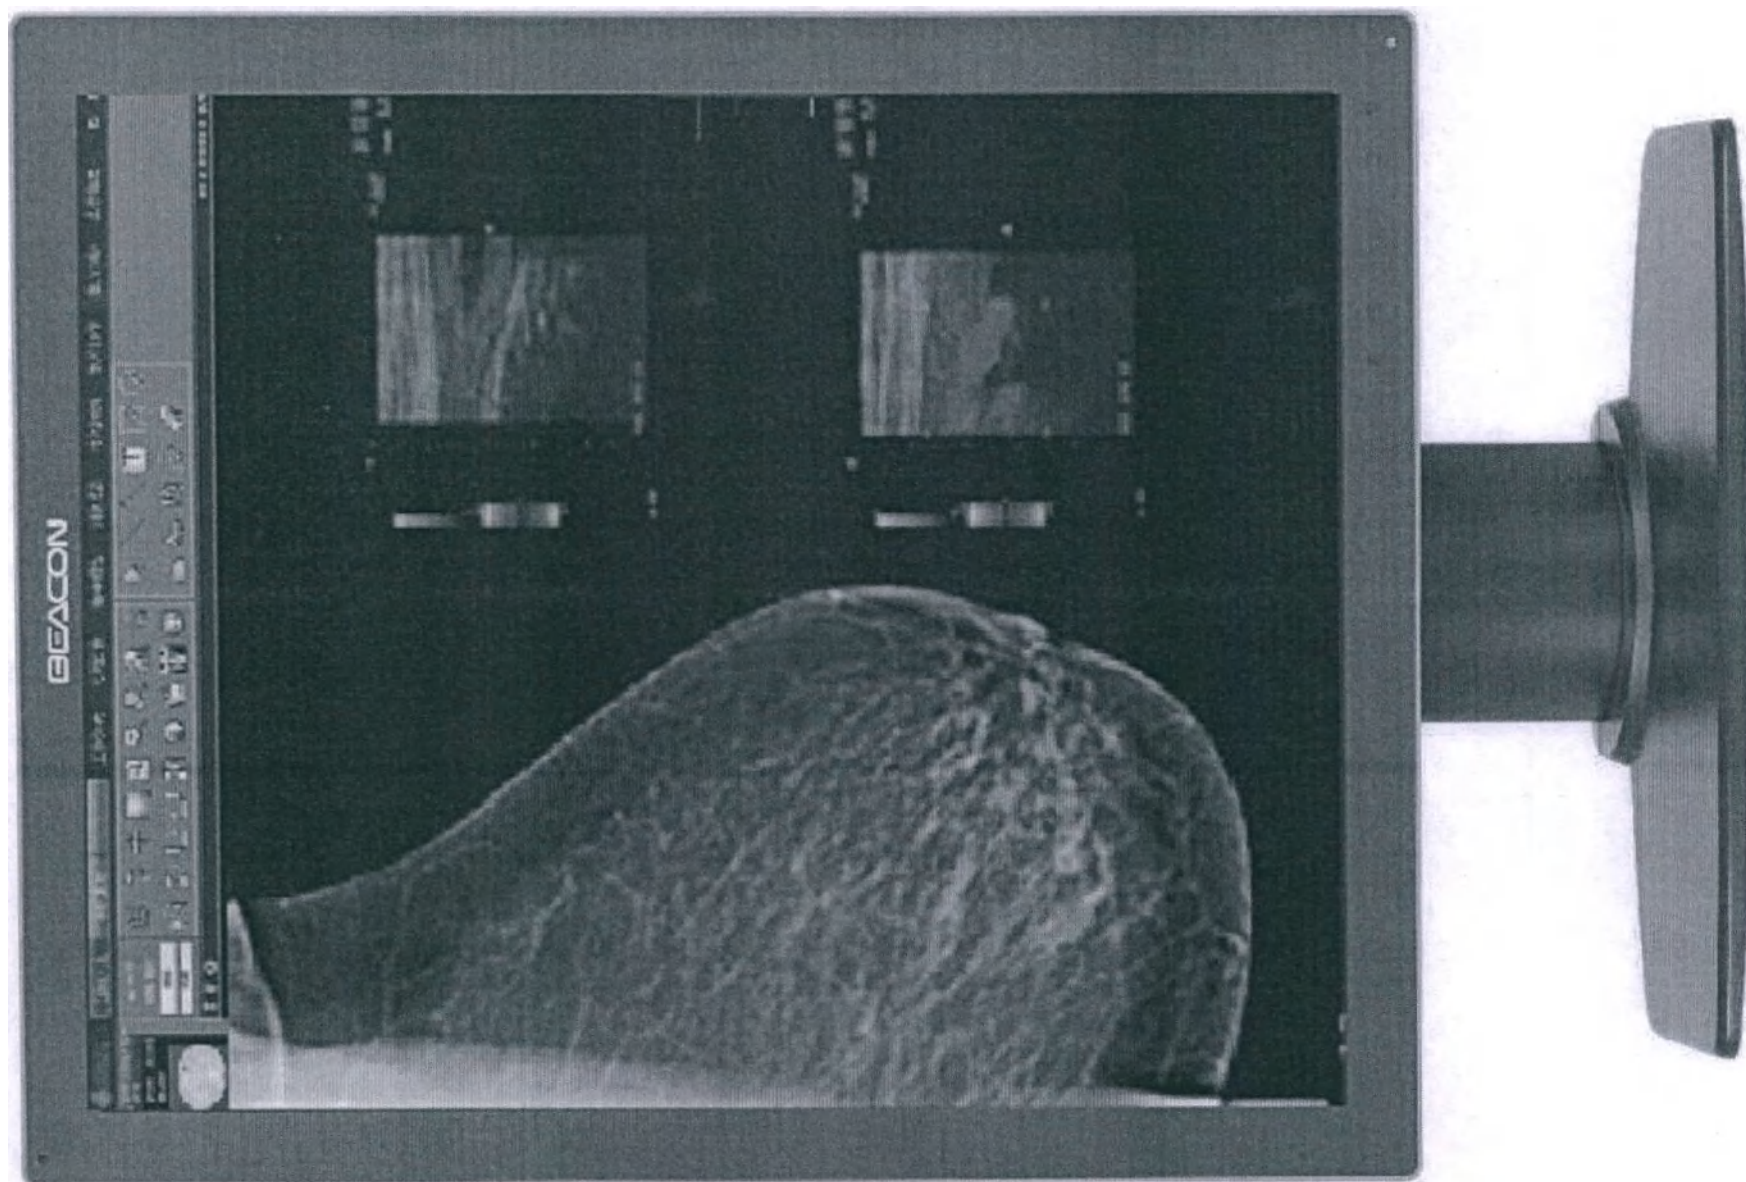


или MD производства BARCO N.V., Бельгия.

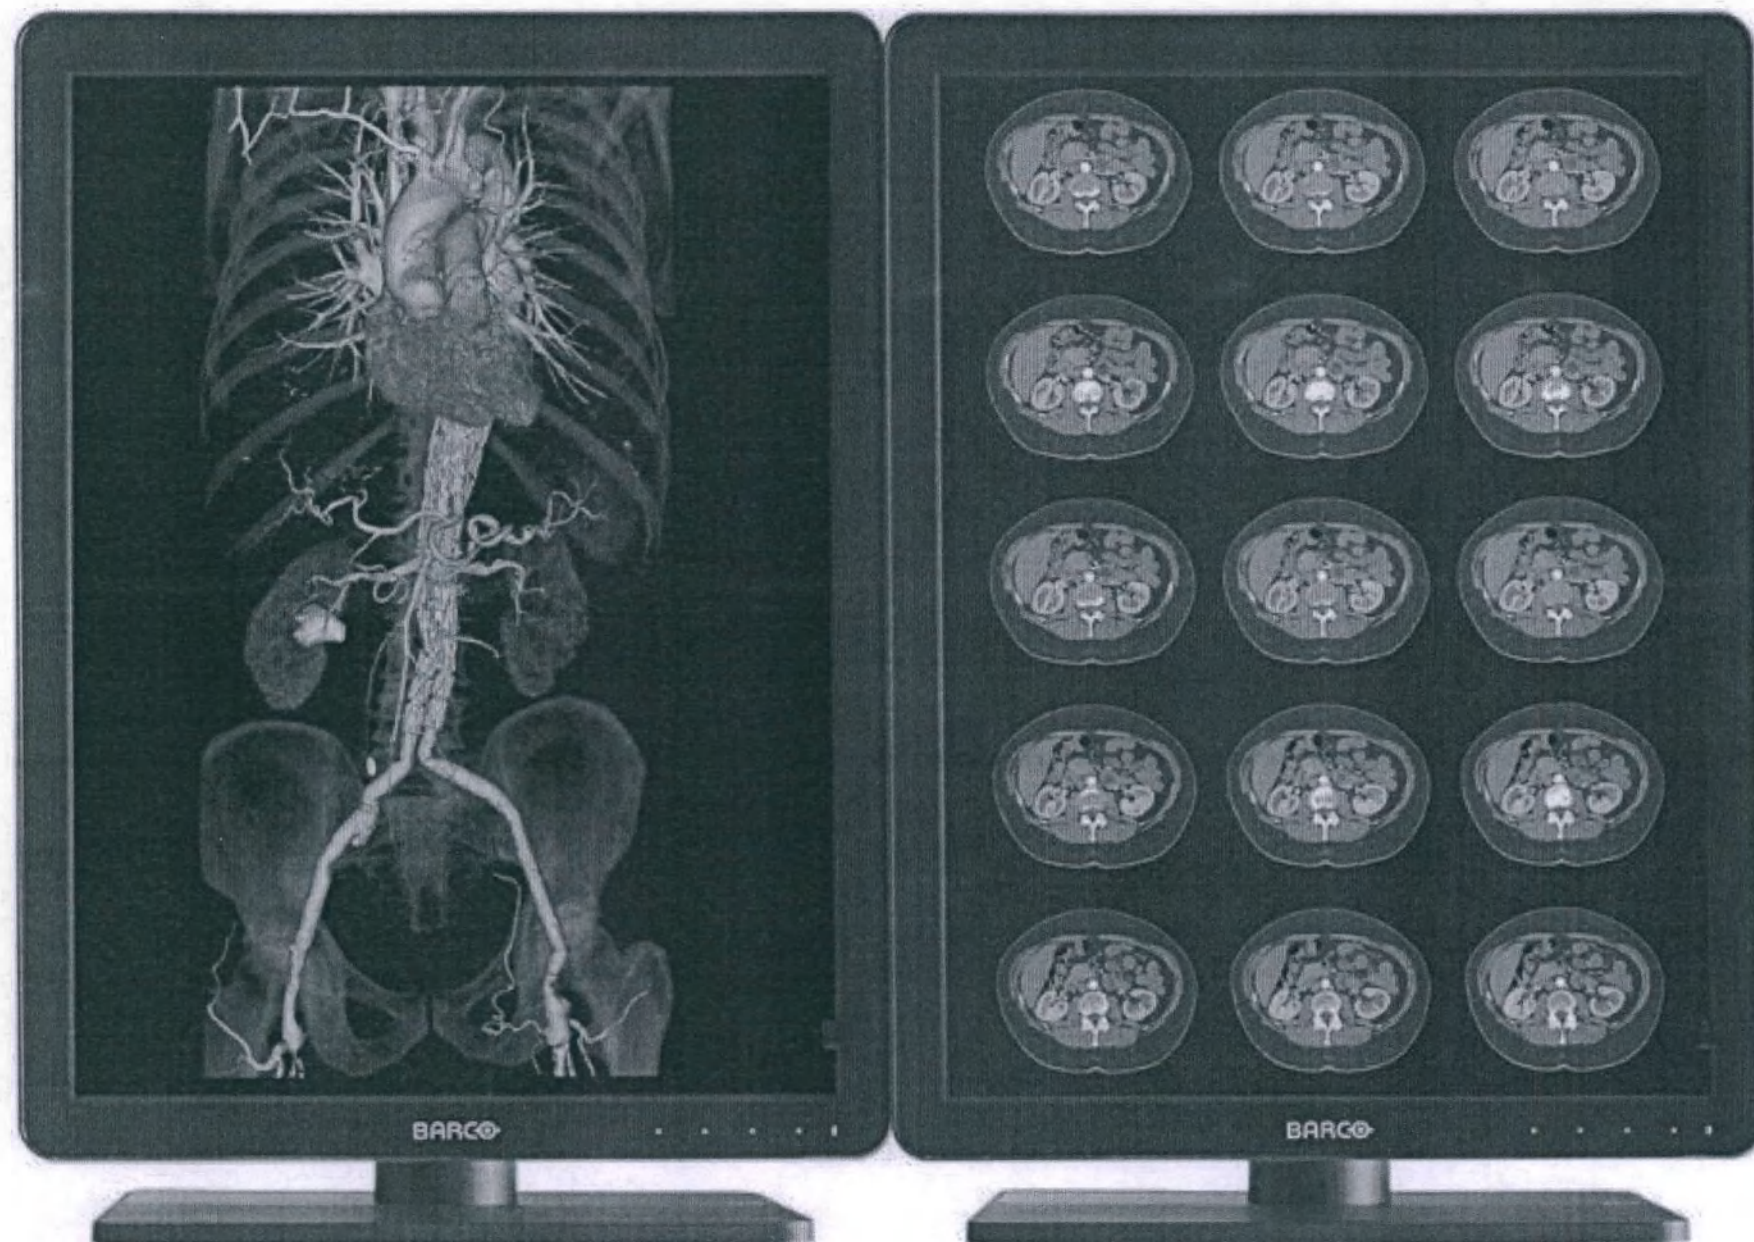


21. Стол для пациента мобильный производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори».




22. Негатоскоп «ИКСВЫЮ» по ТУ 9441-023-74487176-2011 производства ООО «ДИКСИОН», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/11086);

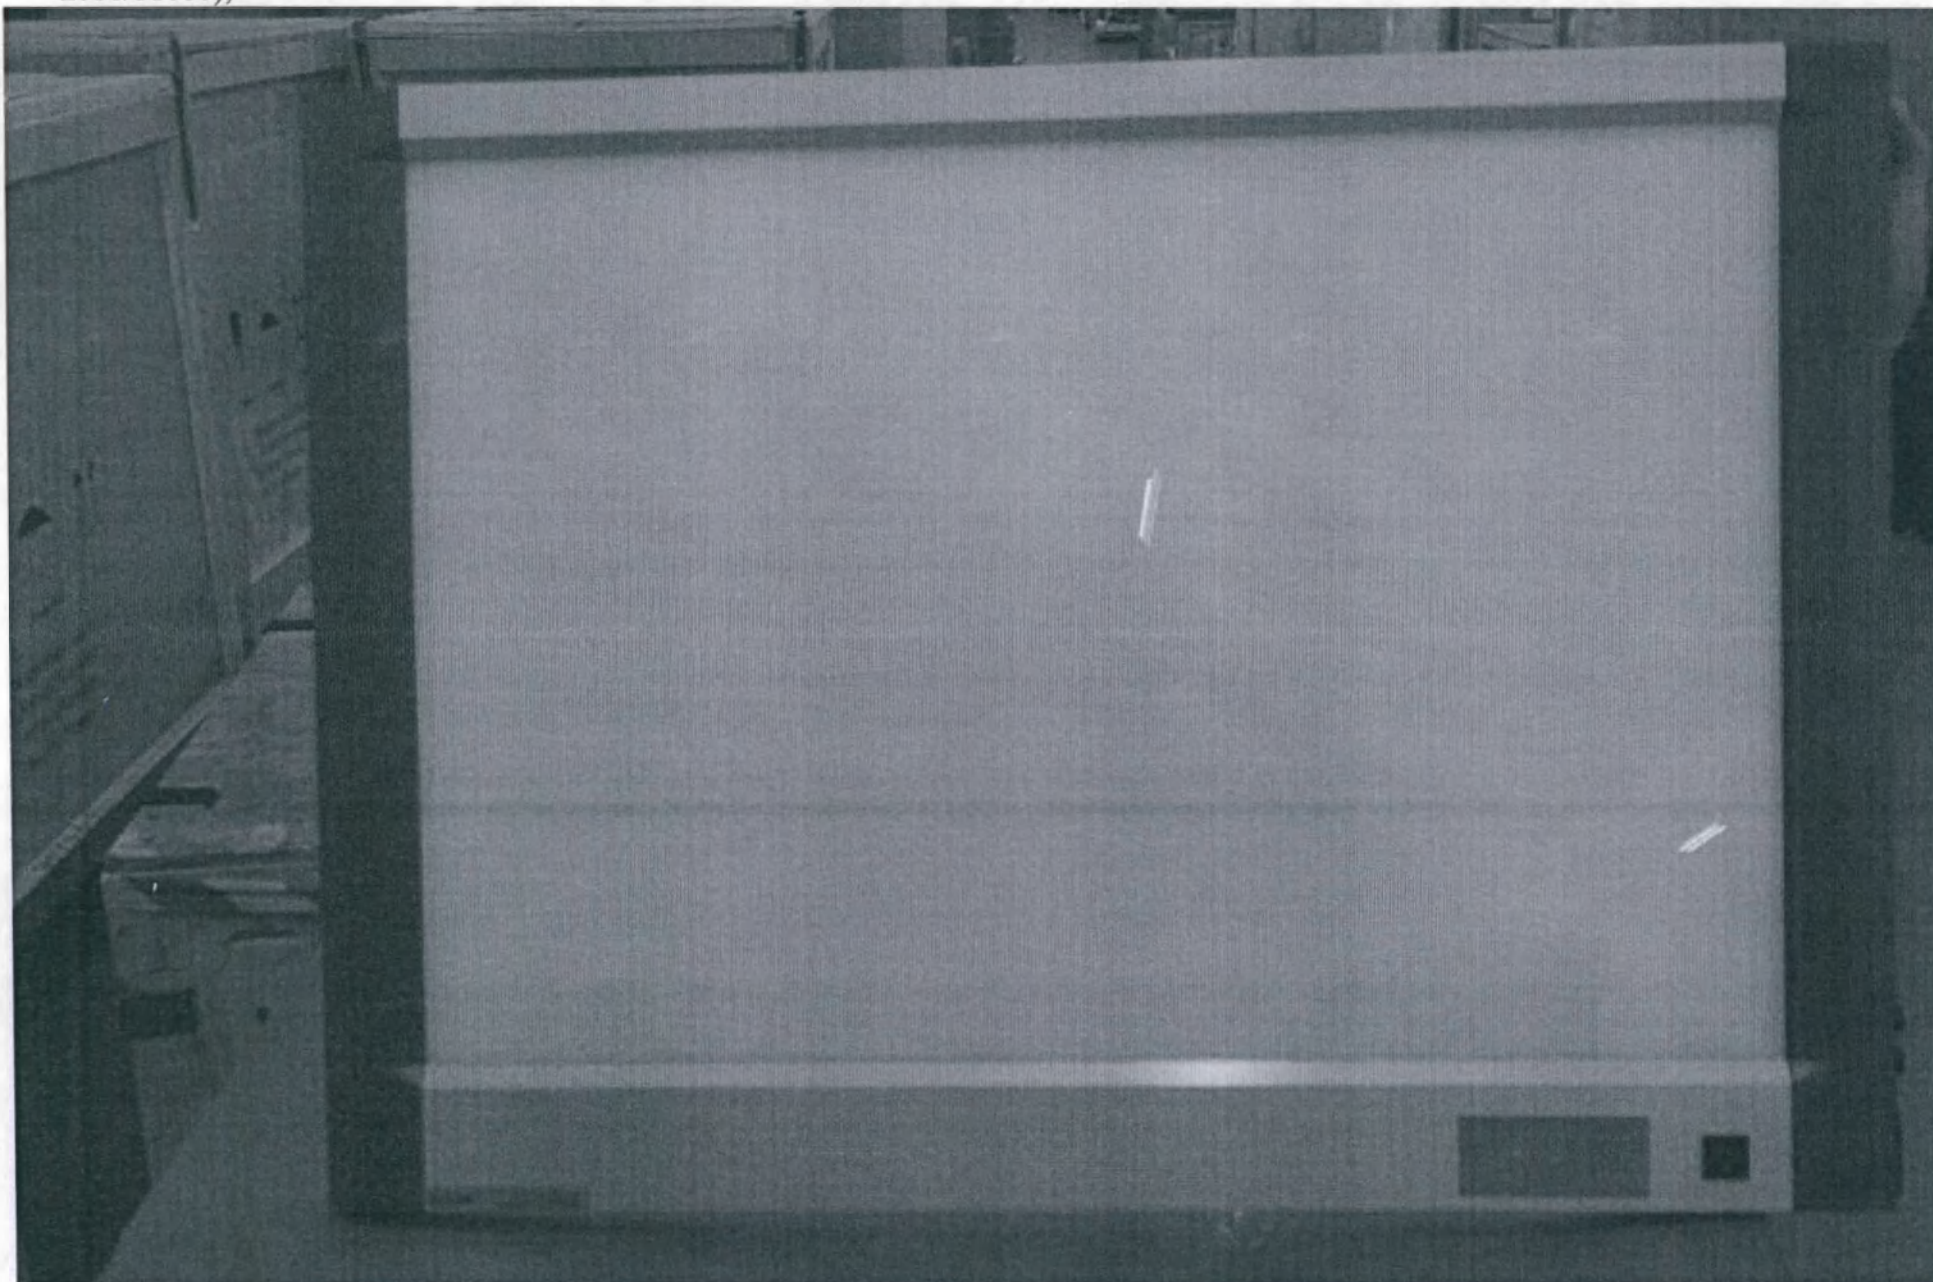


или негатоскоп общего назначения Нега-Н-РМ по ТУ 9452-001-46782692-99 производства ООО «Рентген-Комплект» (РУ № ФСР 2008/02874);

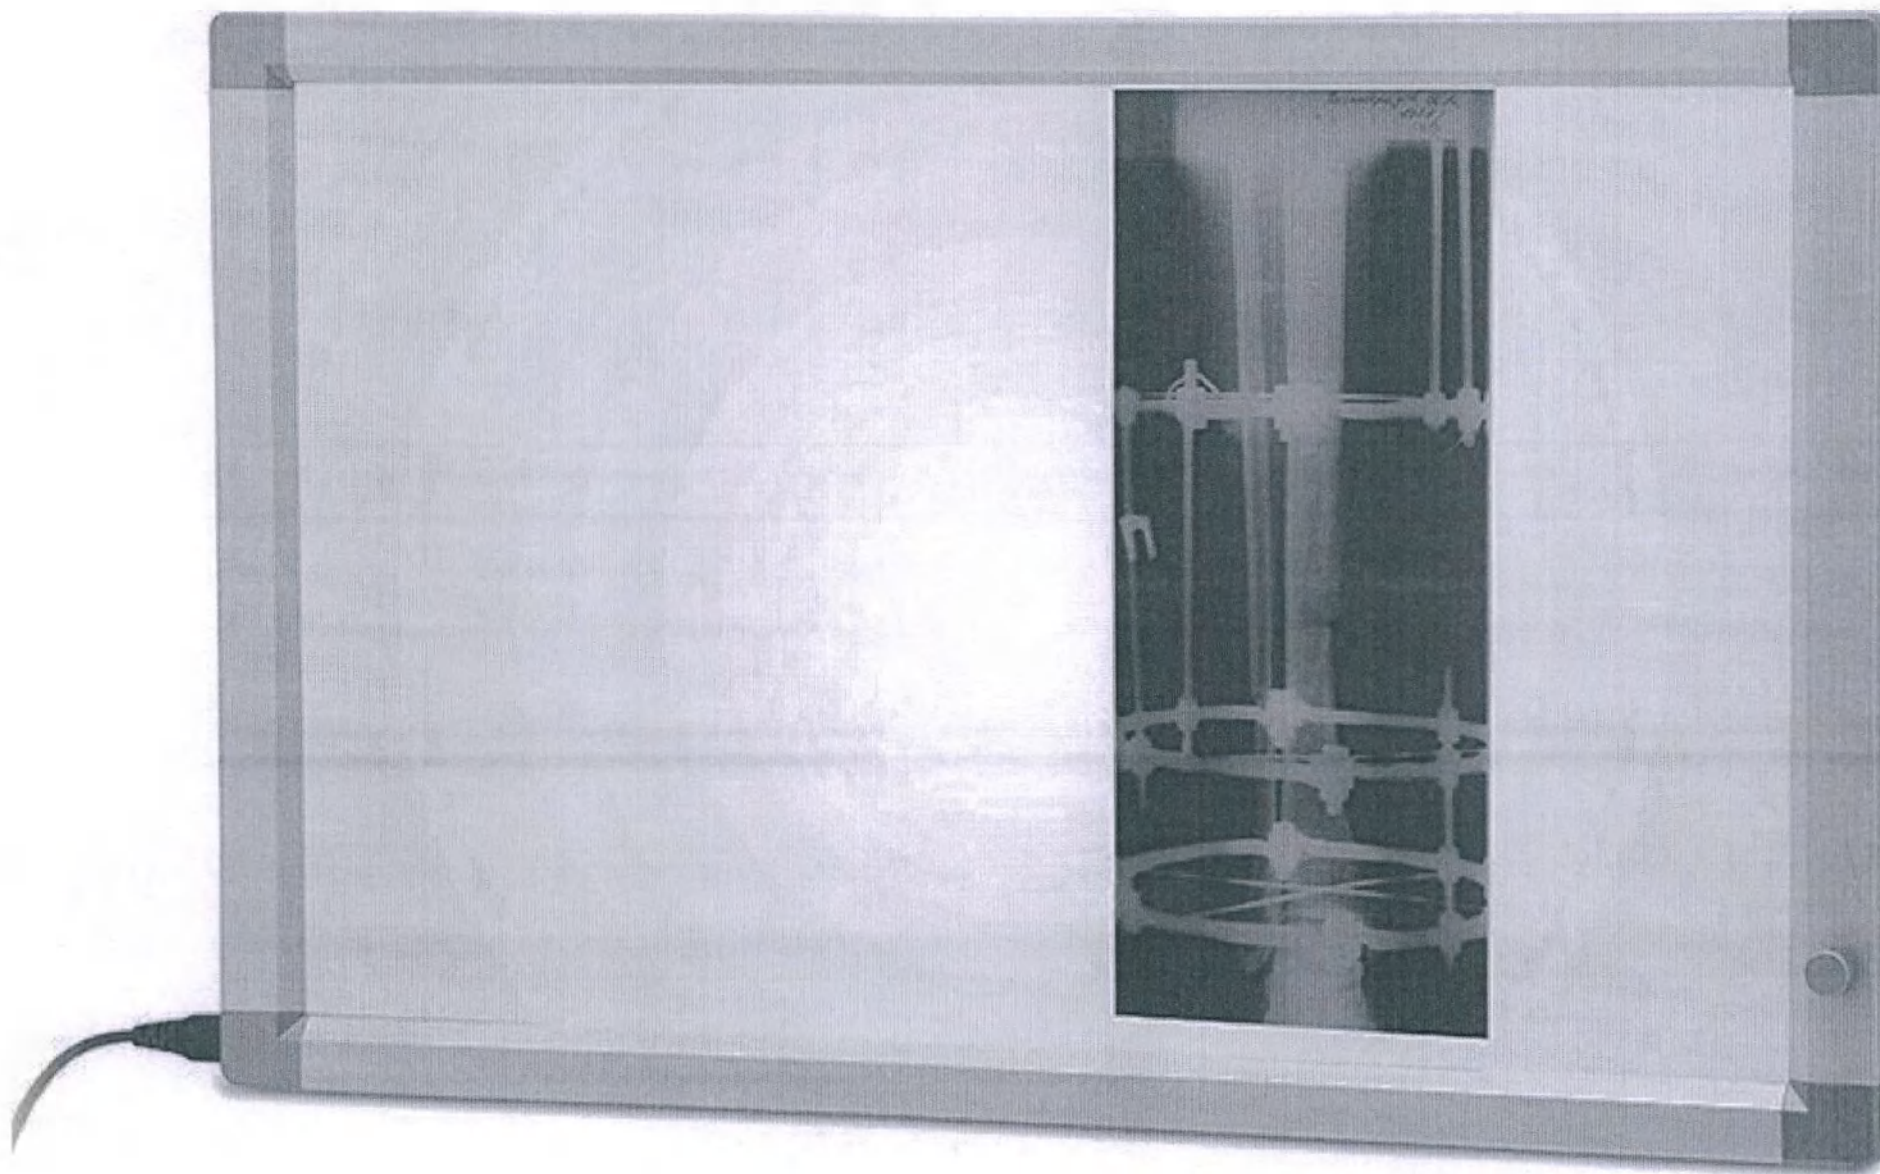


или негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011 производства ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований» (РУ № ФСР 2011/10889);

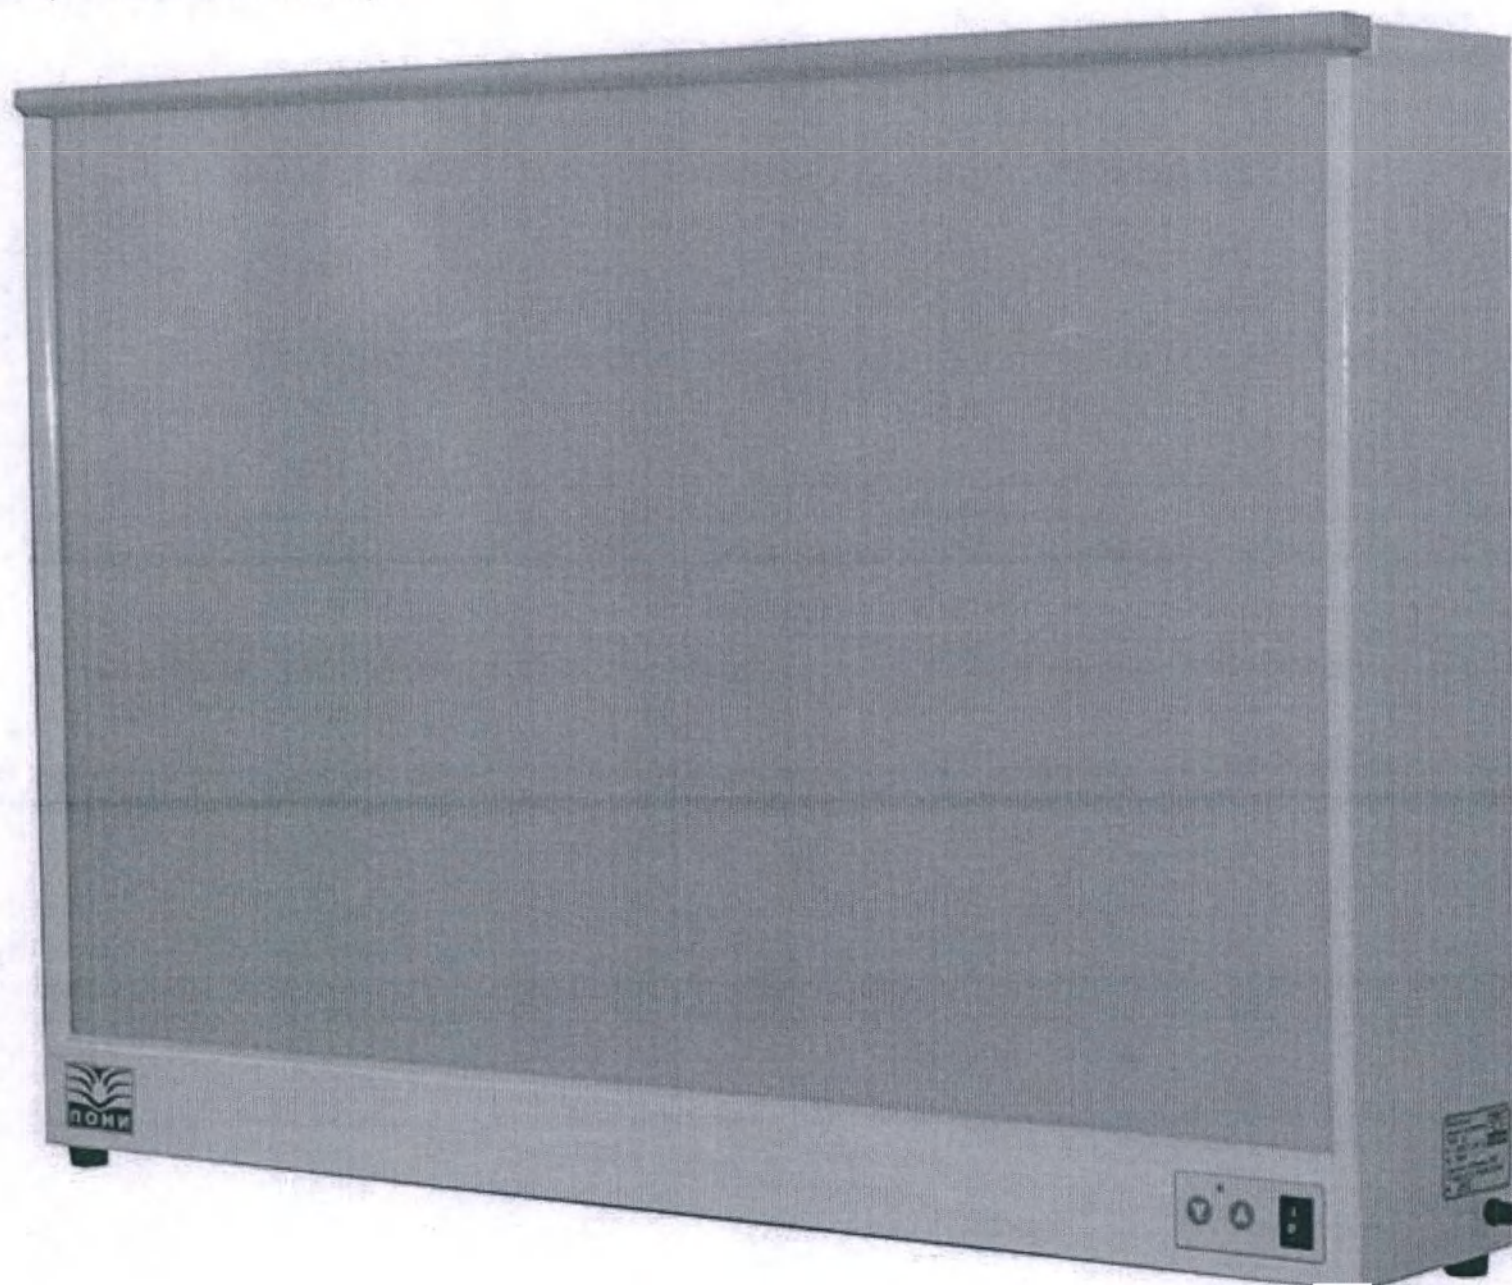

или негатоскоп «АРД» по ТУ 9452-001-35912766-2015 производства ООО «Витако» (РУ № РЗН 2016/4027);

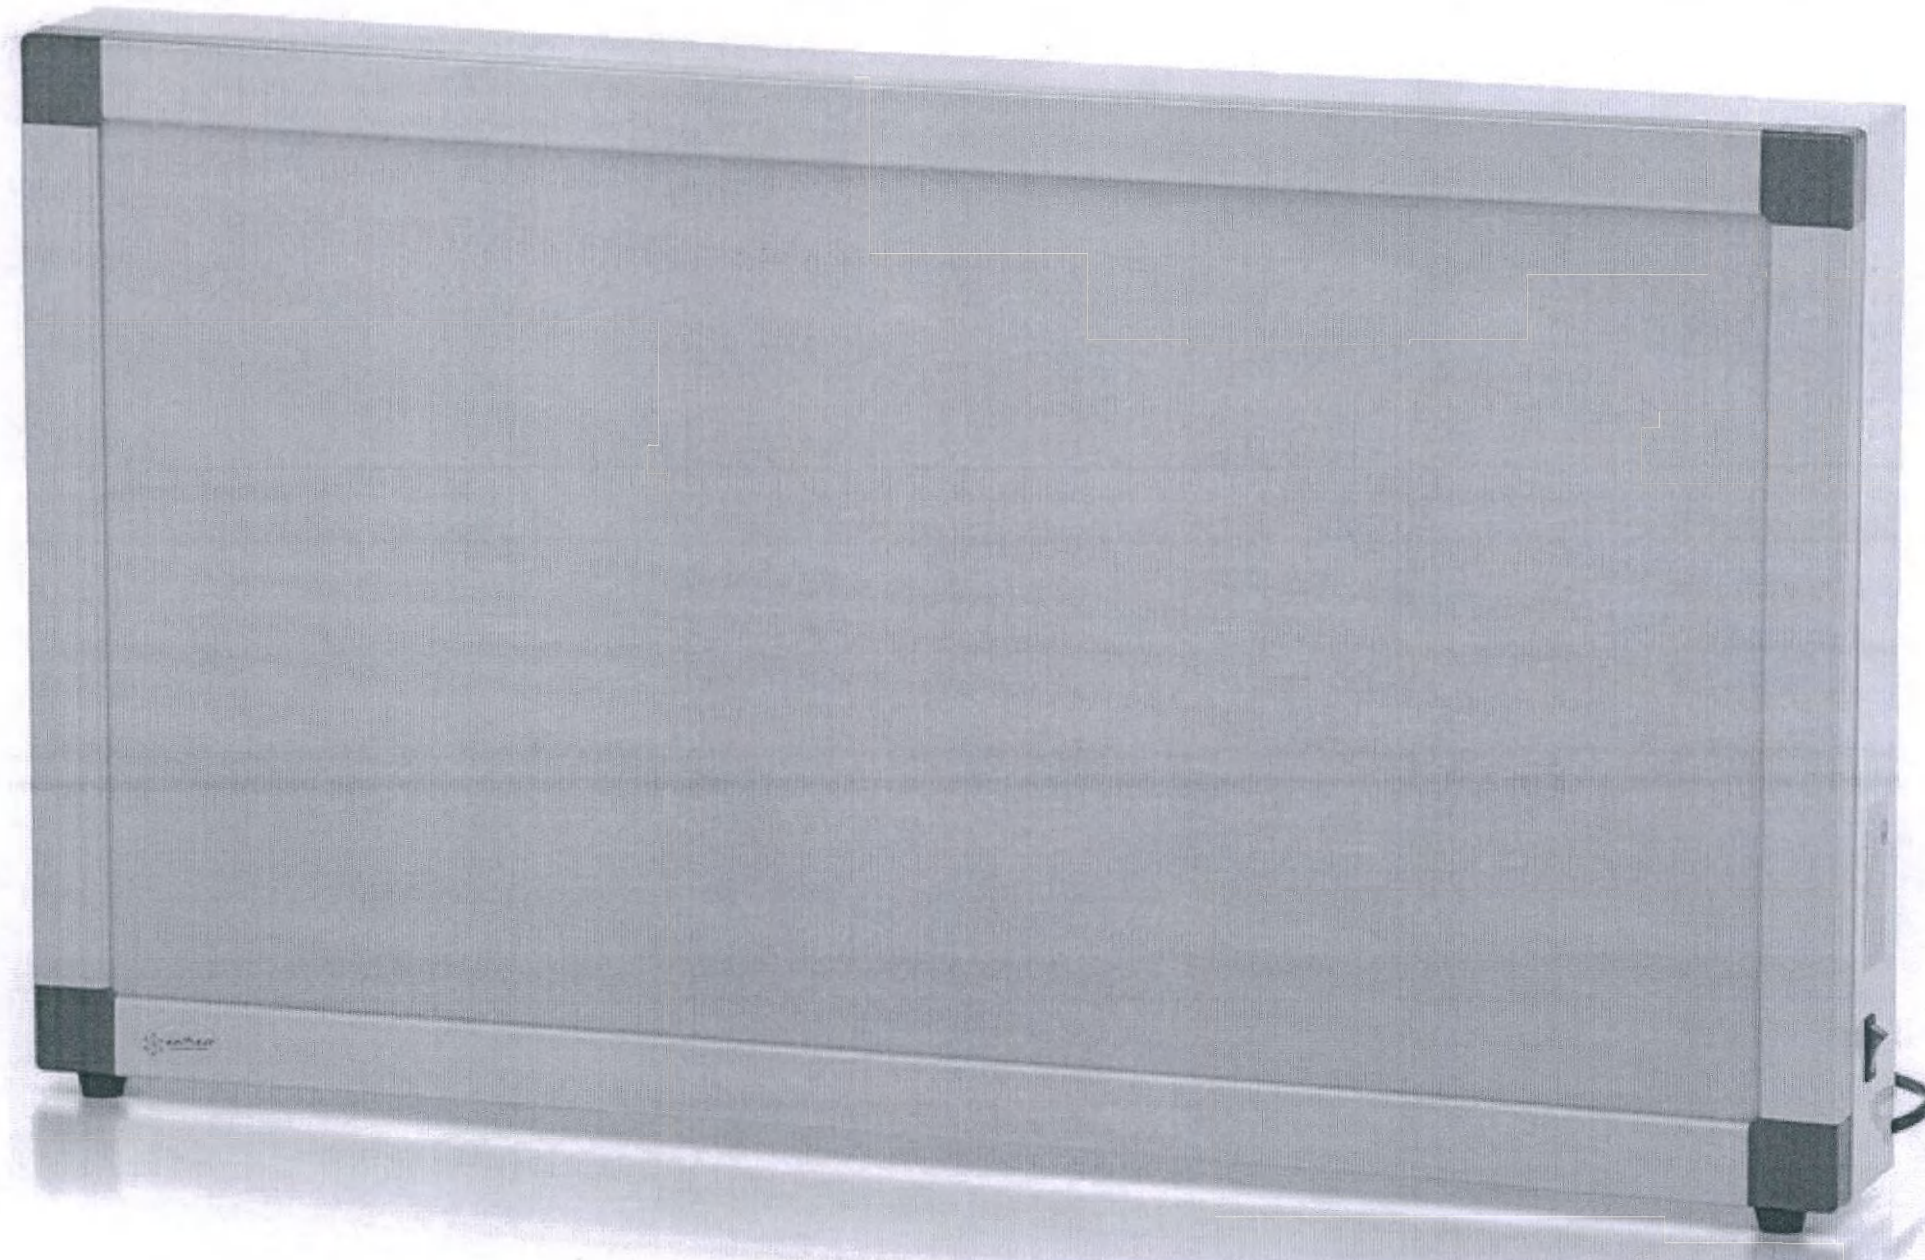


или негатоскоп медицинский серии Н по ТУ 9452-006-52132018-2015 производства ООО "Здоровый Мир" (РУ № РЗН 2016/4440);

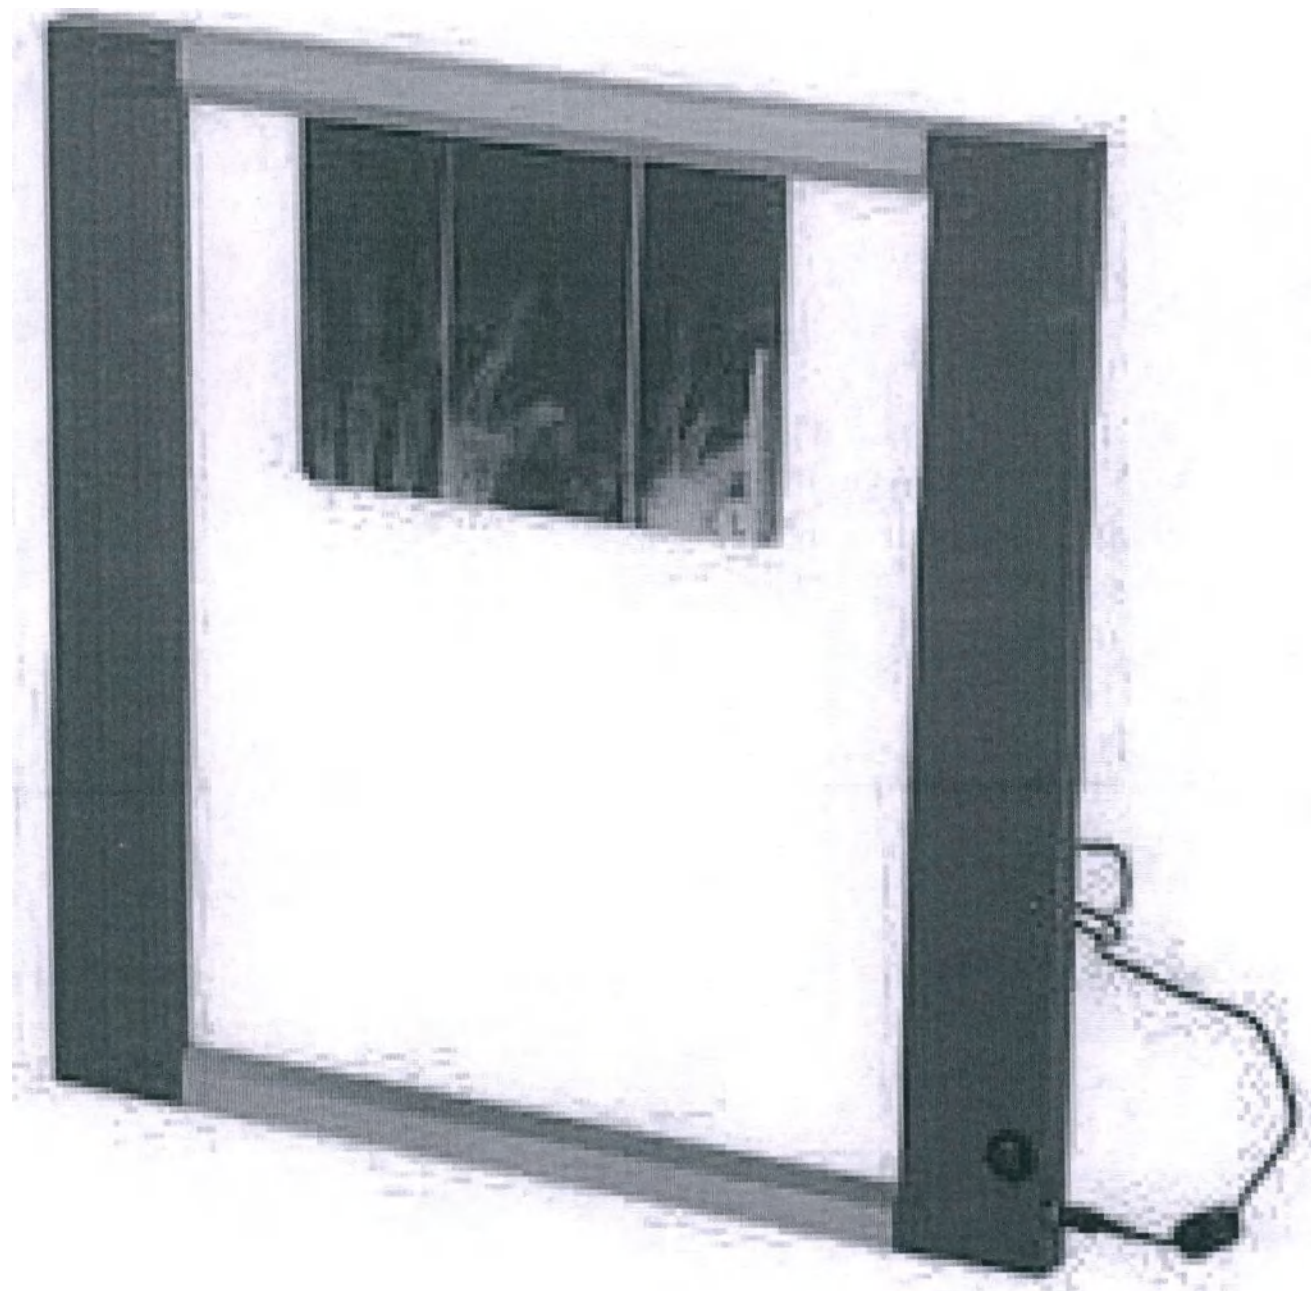


или негатоскопы медицинские НМ модификации: НМ-1, НМ-2, НМ-3 производства ООО «Мединдустрия Сервис» (РУ № РЗН 2013/1376).



23. Рентгенозащитное стекло/окно, эквивалент ослабления не менее 2,5 Pb «TISSA-RP» производства ООО «ТИССА», Республика Беларусь;

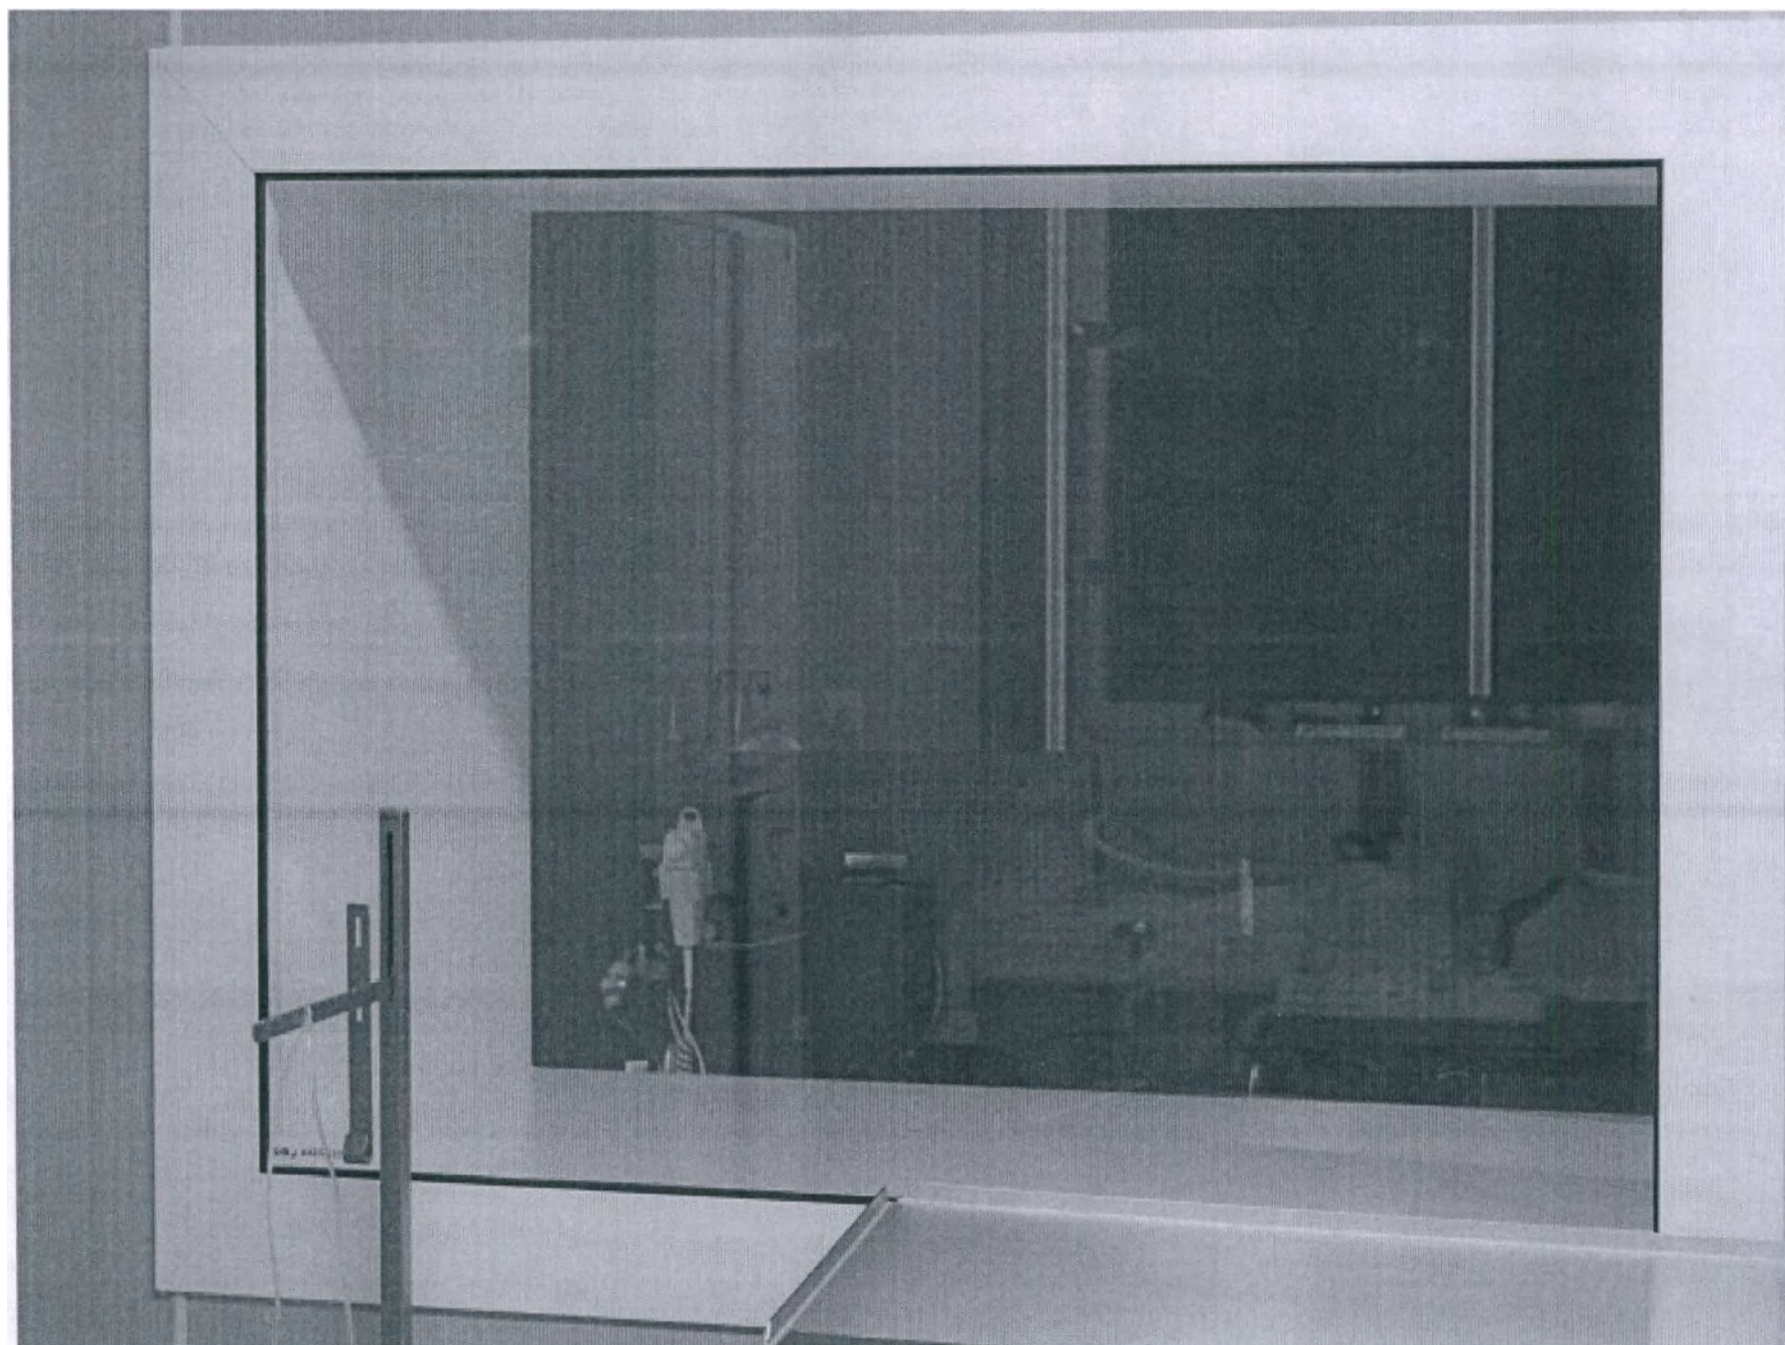


или РЕНЕКС ОСРЗ производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия.

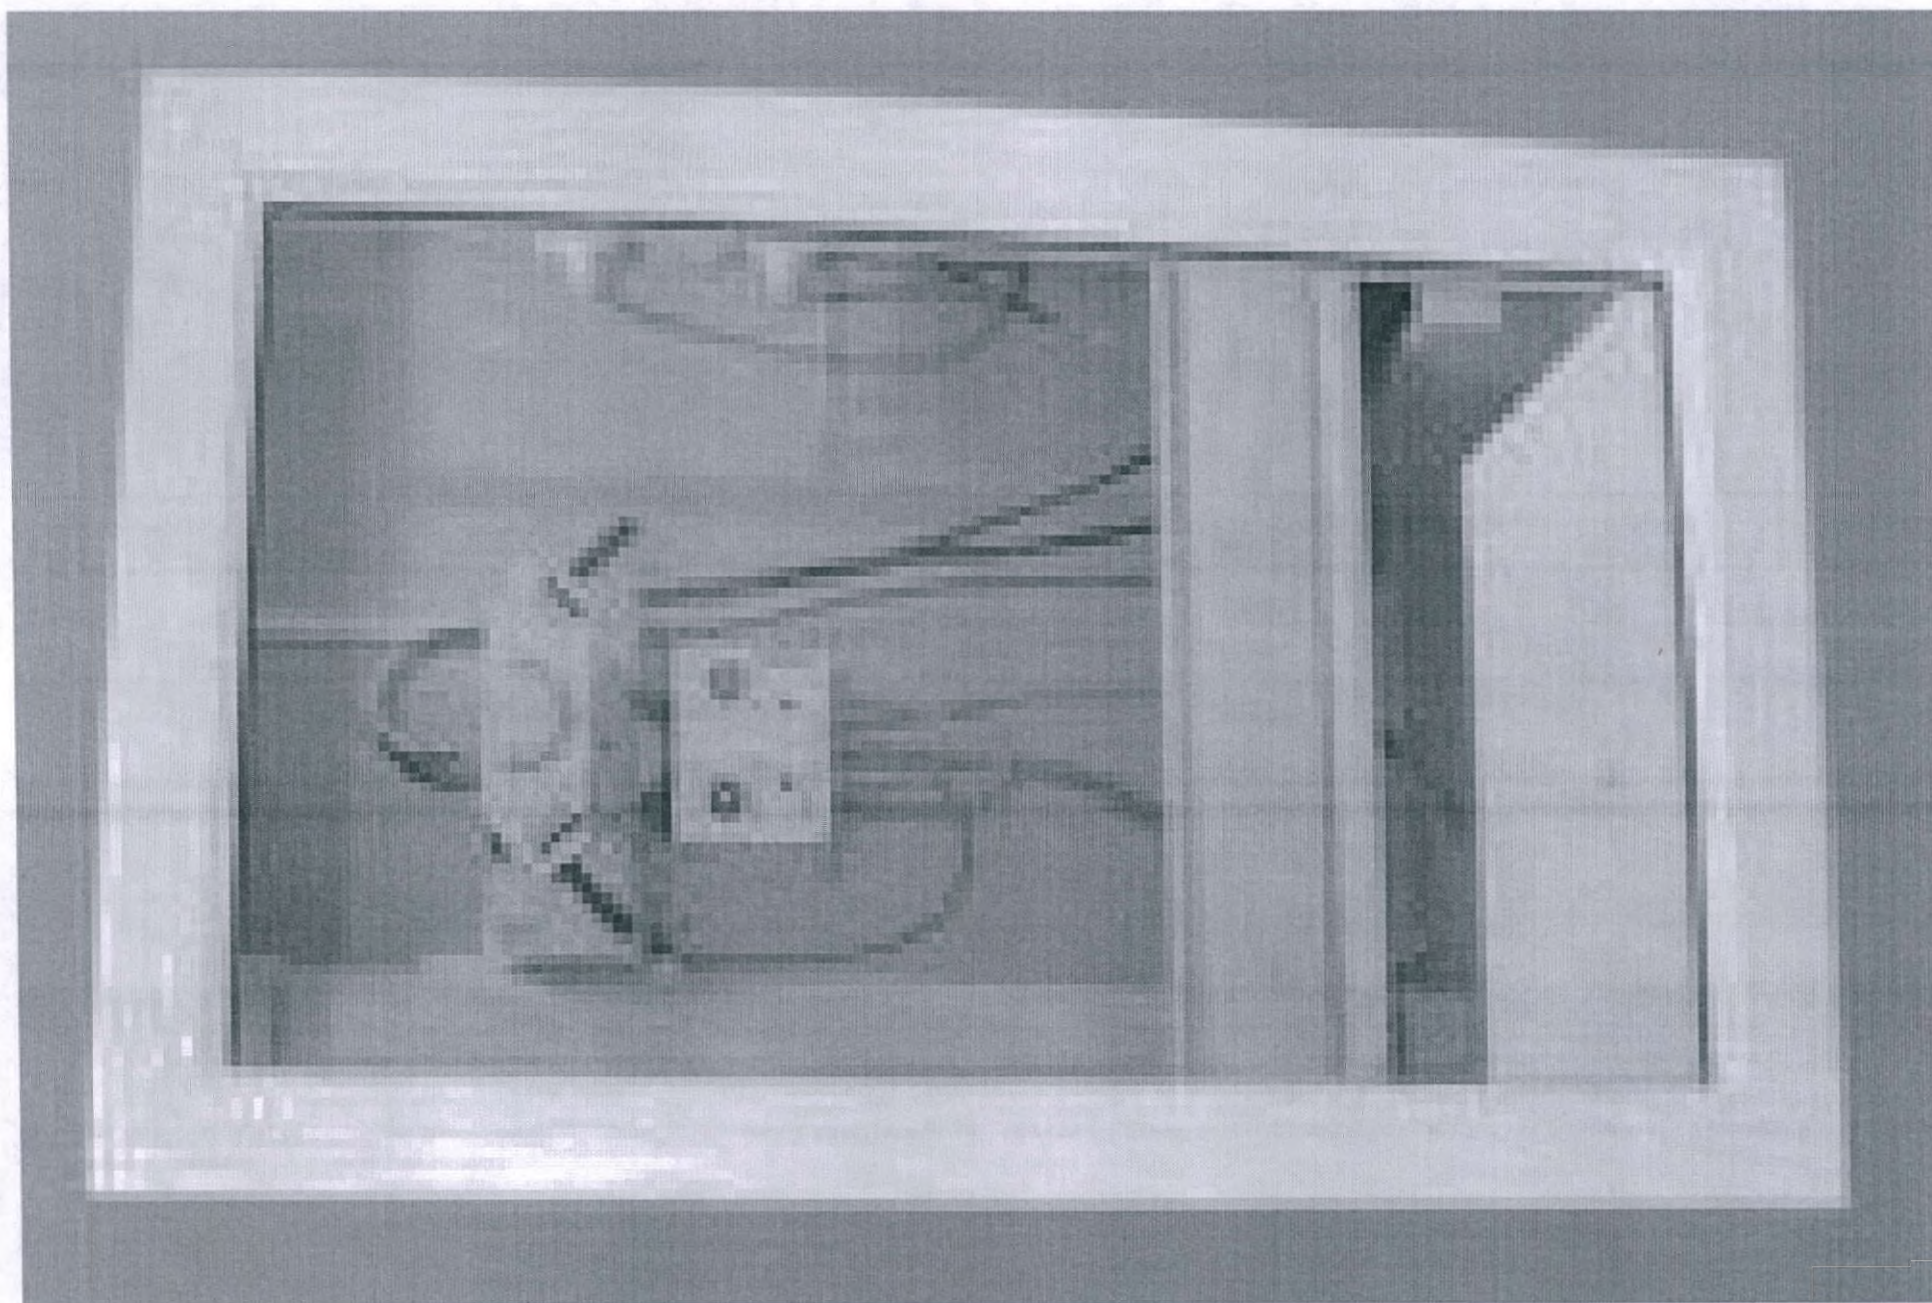

24. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-"РЕНЕКС" по ТУ 9398-010-21009821-2004 производства ЗАО «РЕНЕКС», Российская Федерация (РУ № ФСР 2008/03184);






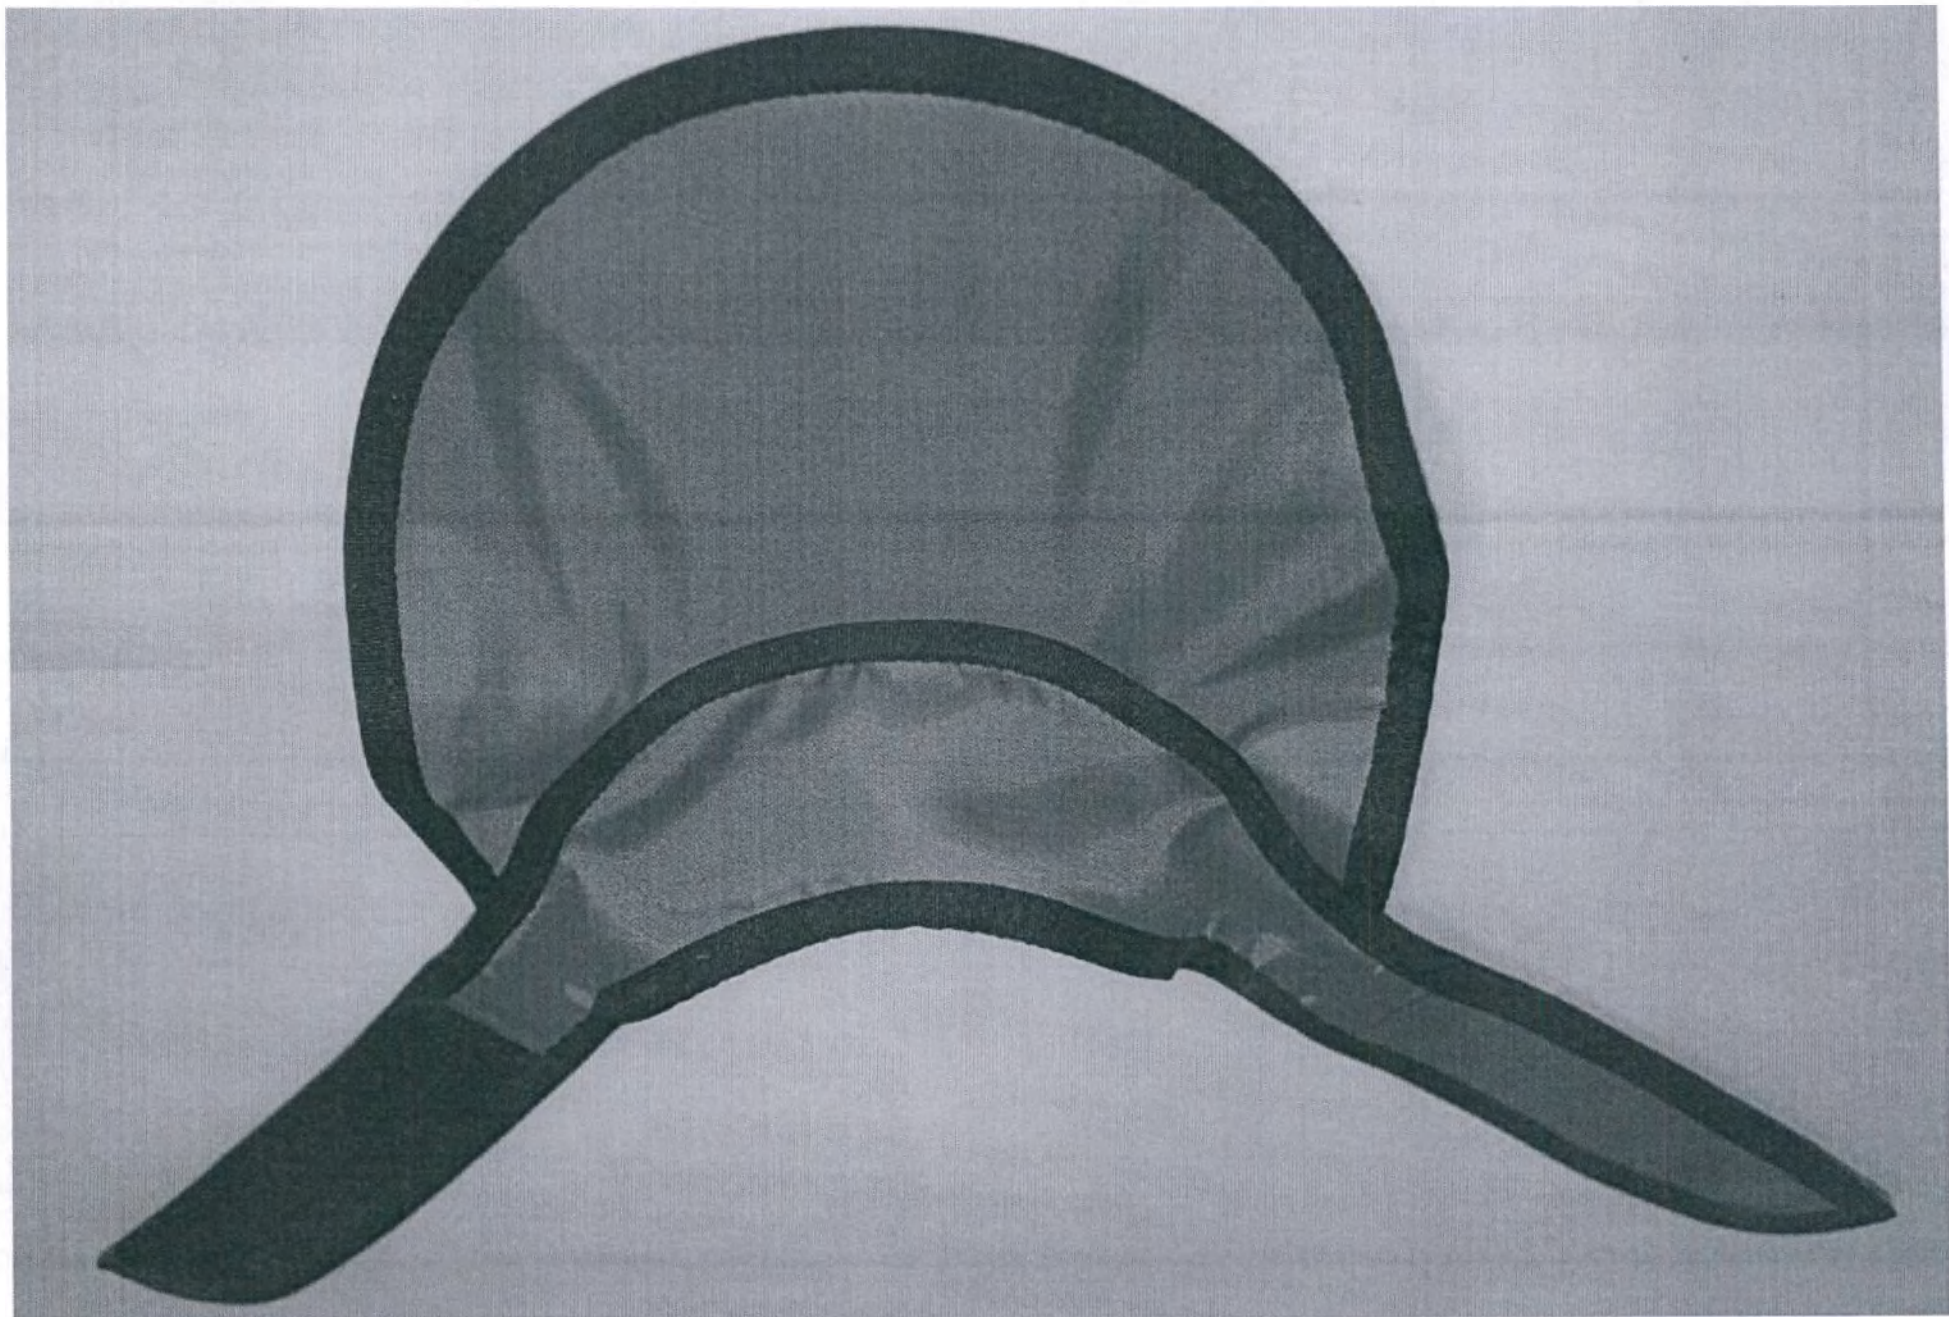



или комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006 производства ООО "МП НПФ «Гаммамед-П», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/10727);



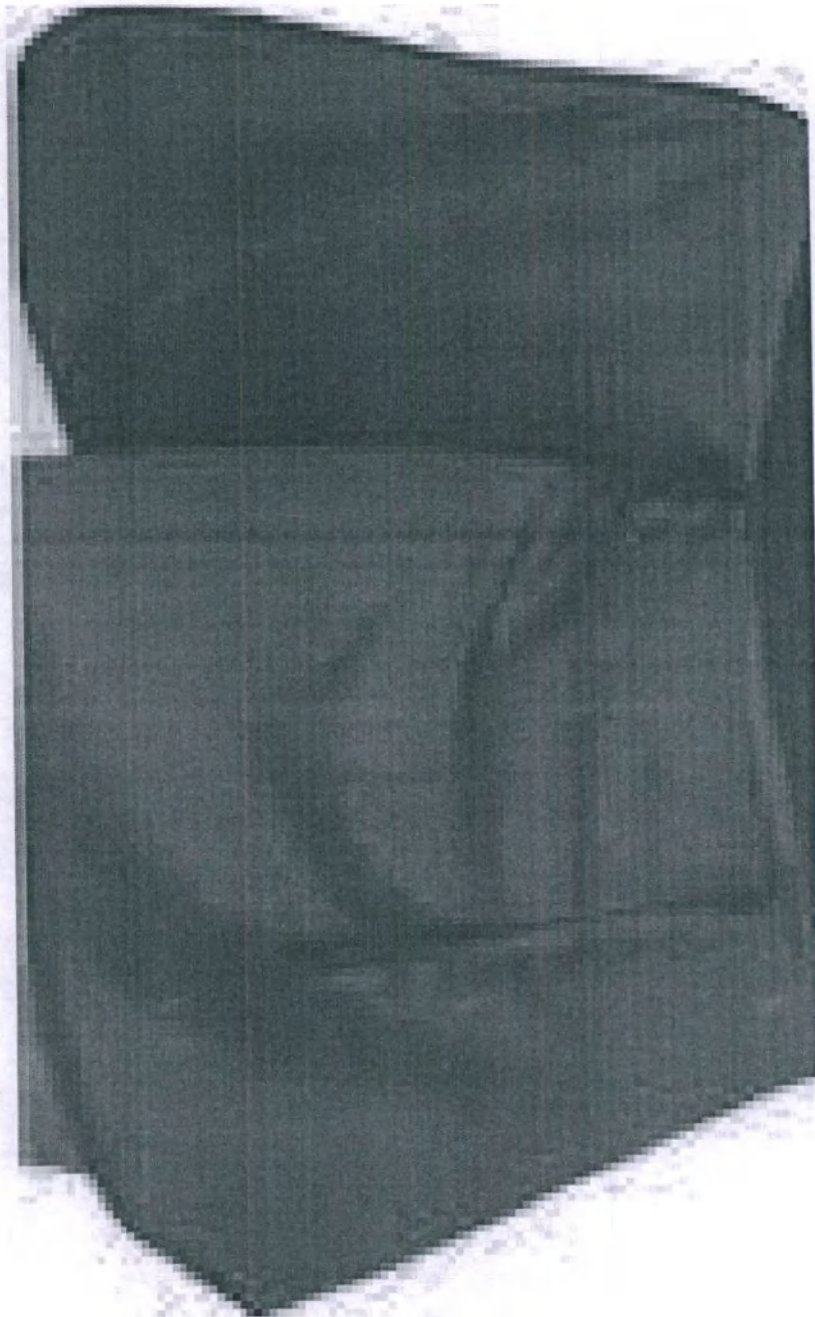


или комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001 производства ООО «Рентген-Комплект», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/10477).

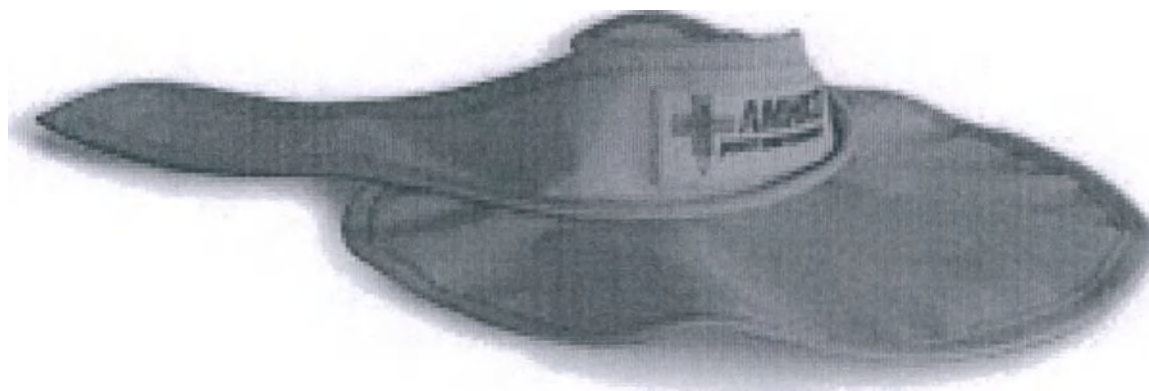


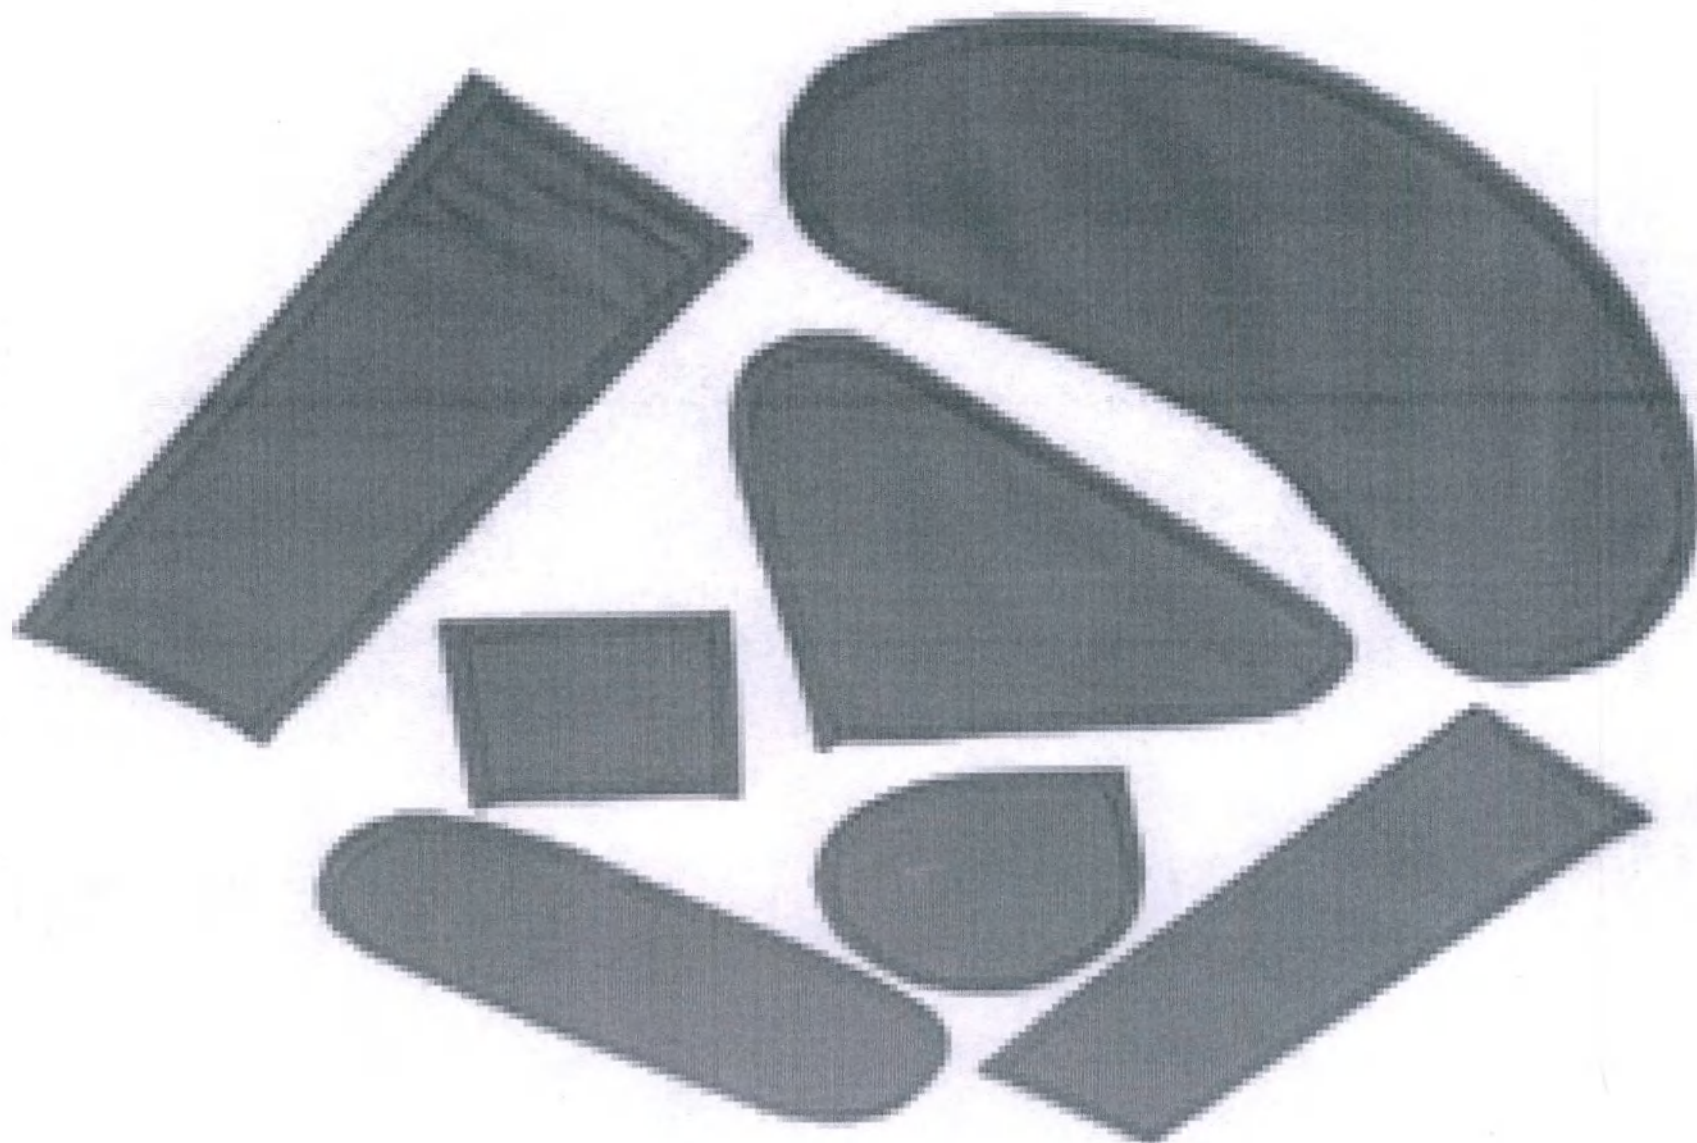


25. Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002 производства ЗАО «ПОНИ», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/11811);

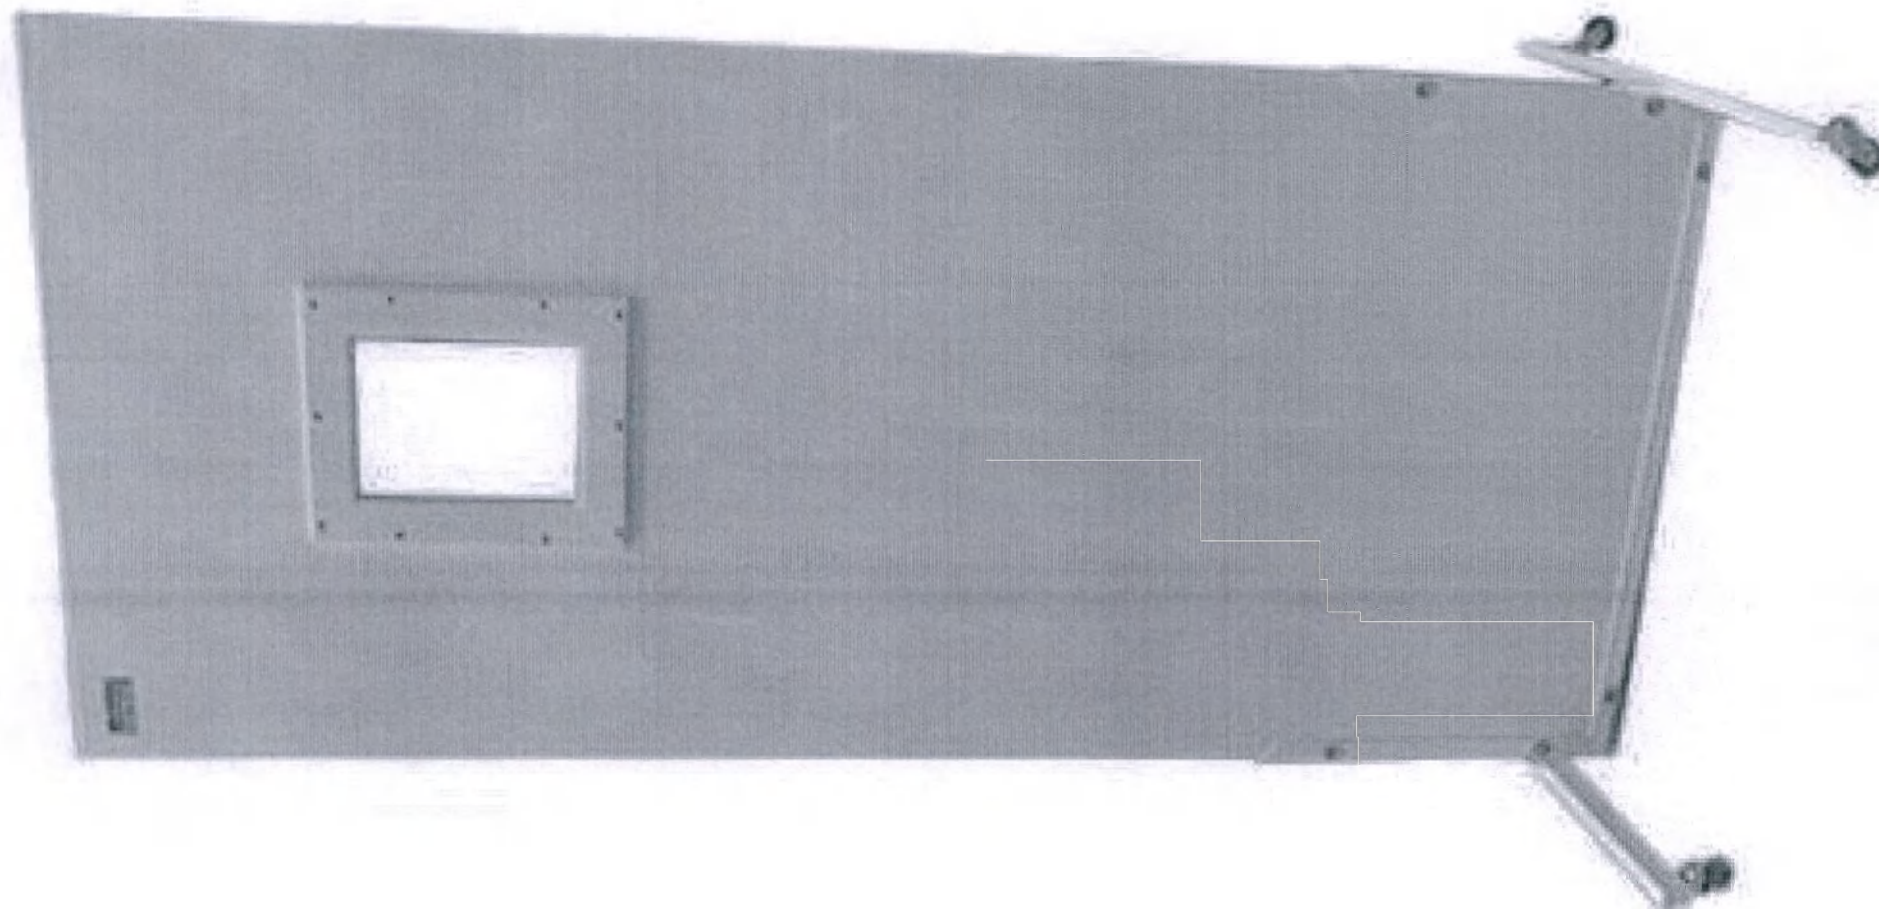


или ширмы рентгенозащитные резиносвинцовые передвижные по ТУ 9452-010-46782692-2001 производства «Рентген-Комплект», Российская Федерация (ПУ № ФСР 2011/10476).

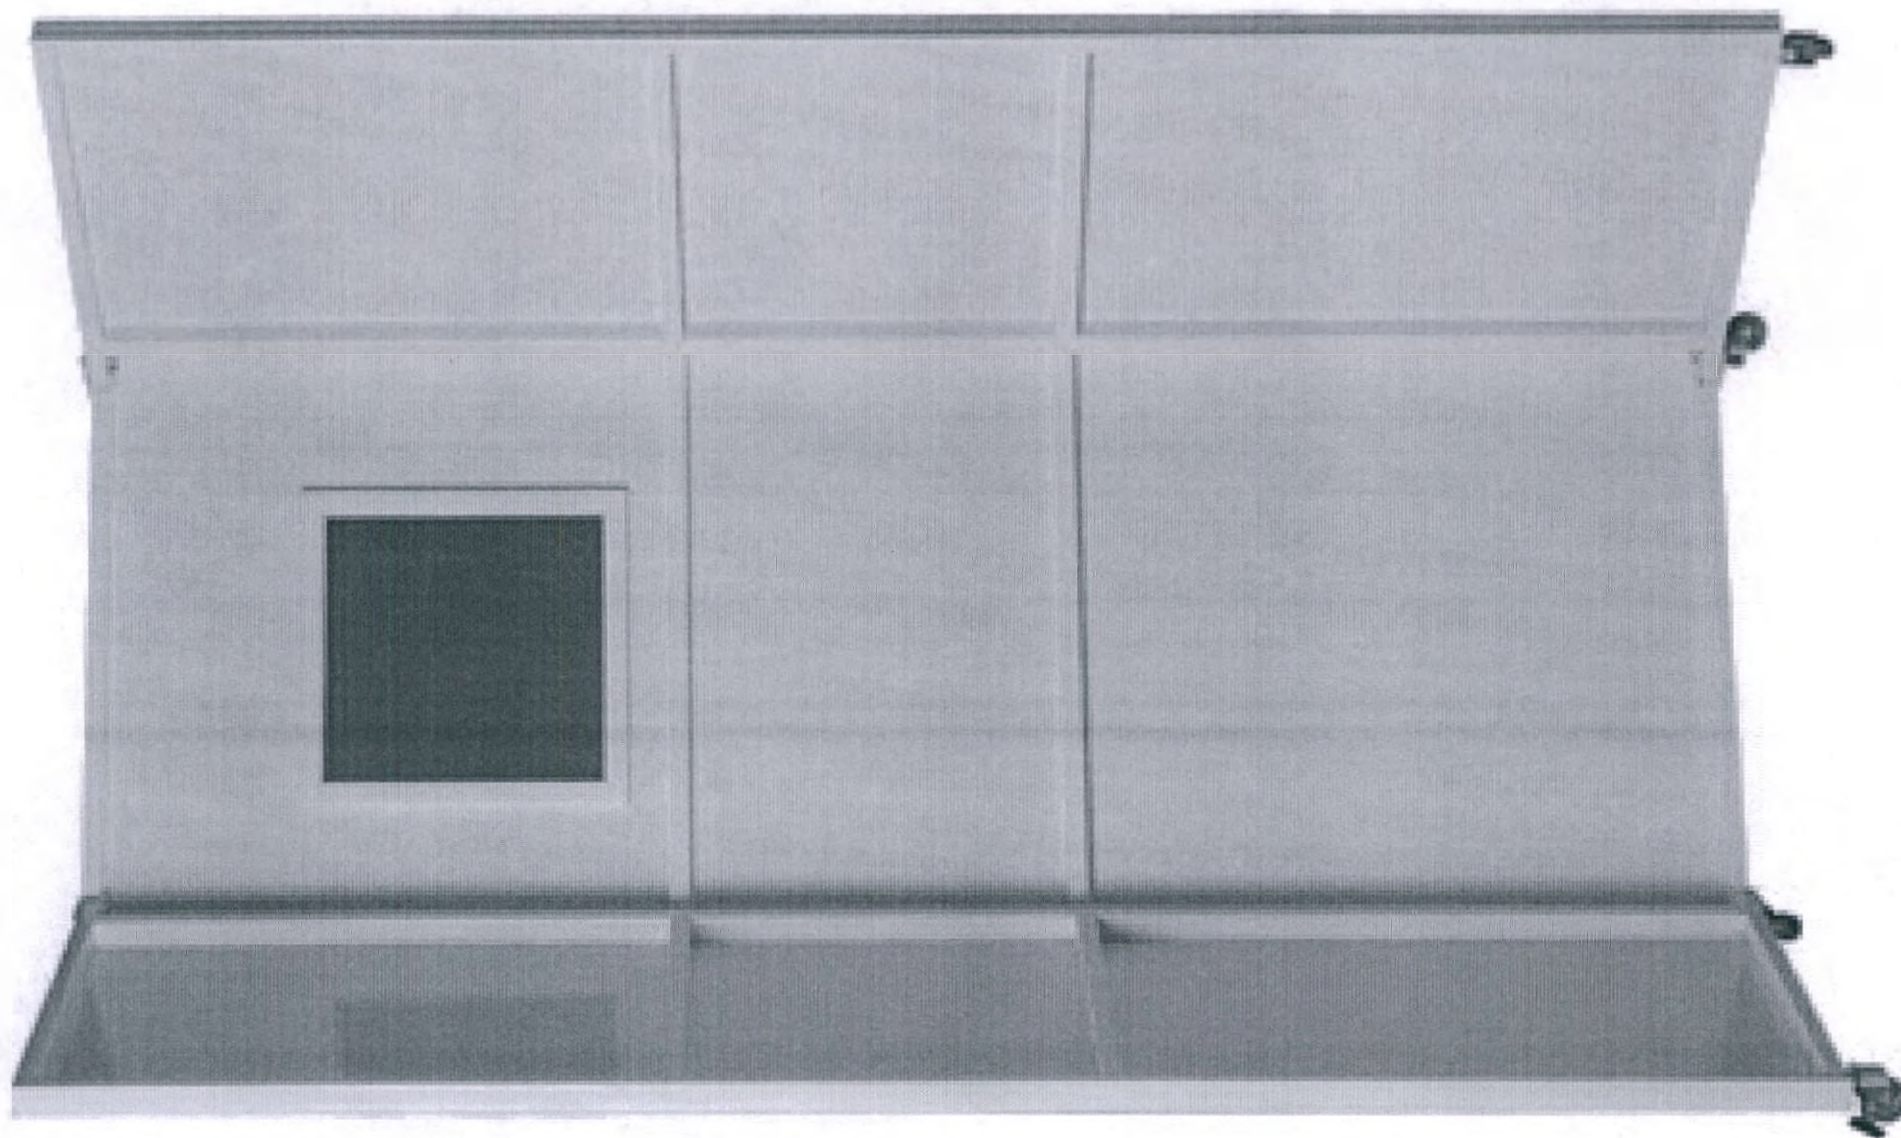


26. Люлька детская двойного поворота передвижная для полипозиционных исследований ЛДДП-1 по ТУ 9442-027-11396834-2006 производства ООО «СпектрАп», Российская Федерация (РУ № ФСР 2010/09430).

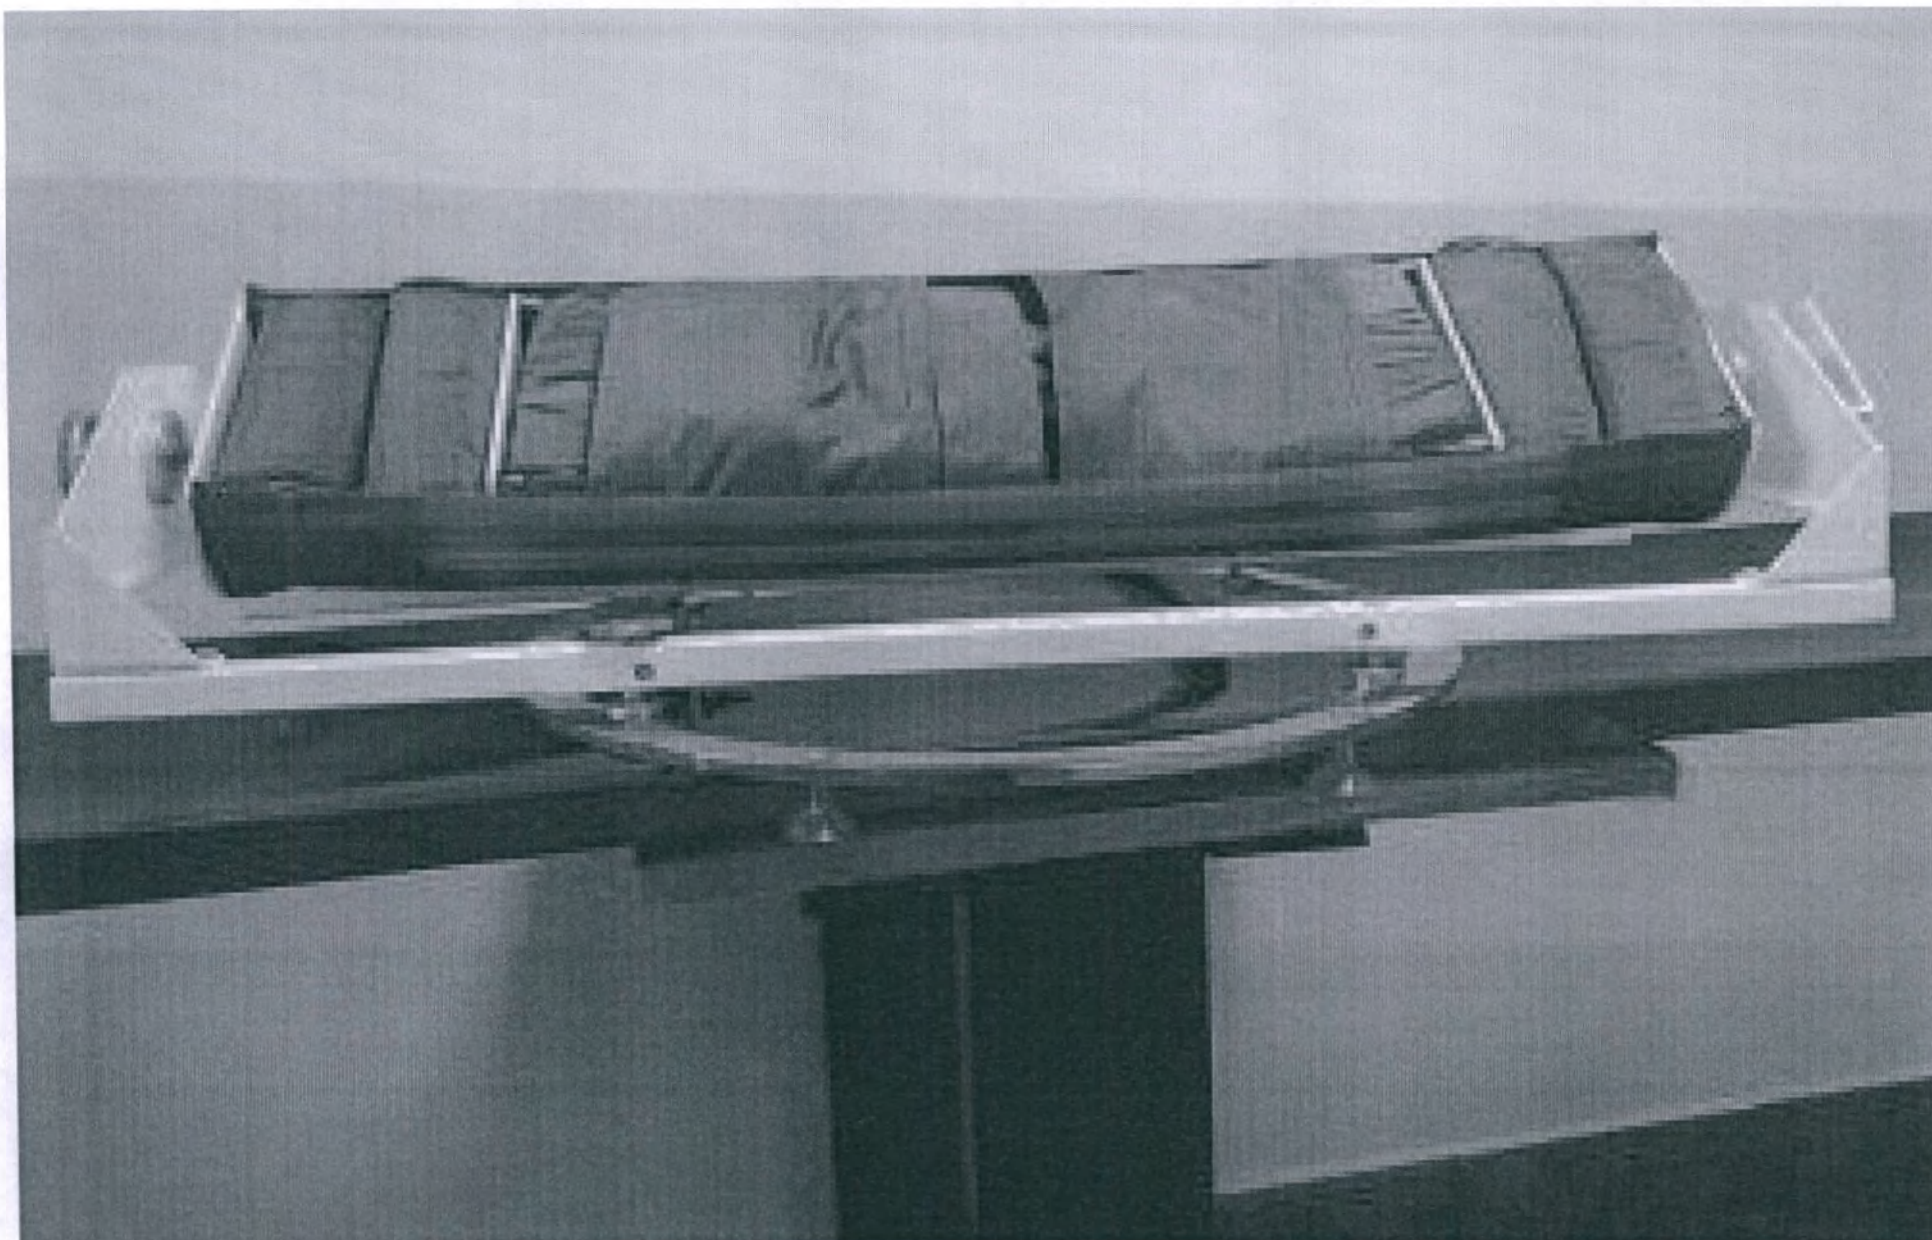

27. Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-800020198-2010 производства ИП Давлетов Д.Я., Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/09994);

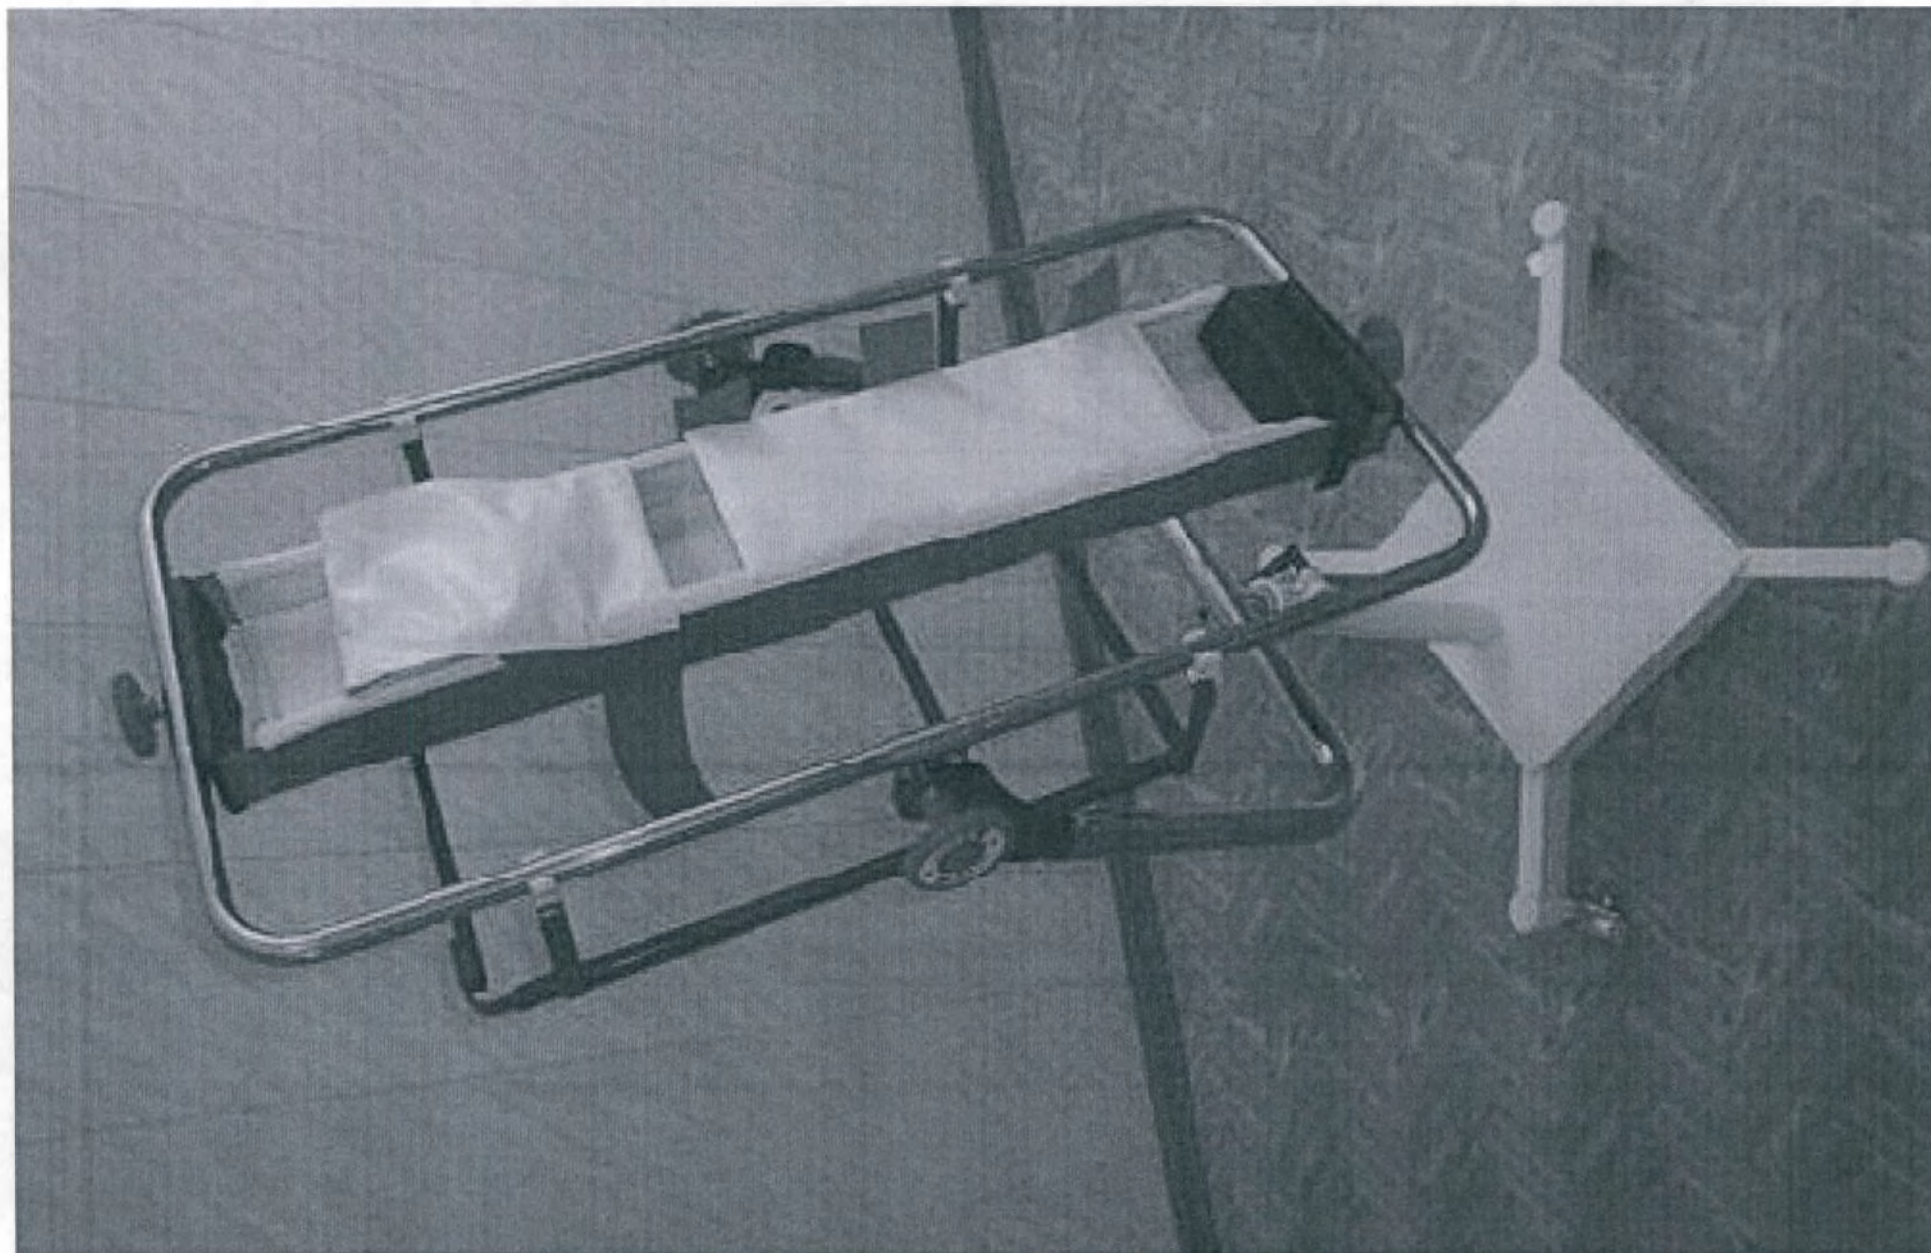

или устройство для позиционирования детей Octopaque или Minipaque или Octoroll производства фирмы Oktostop inc. Канада;

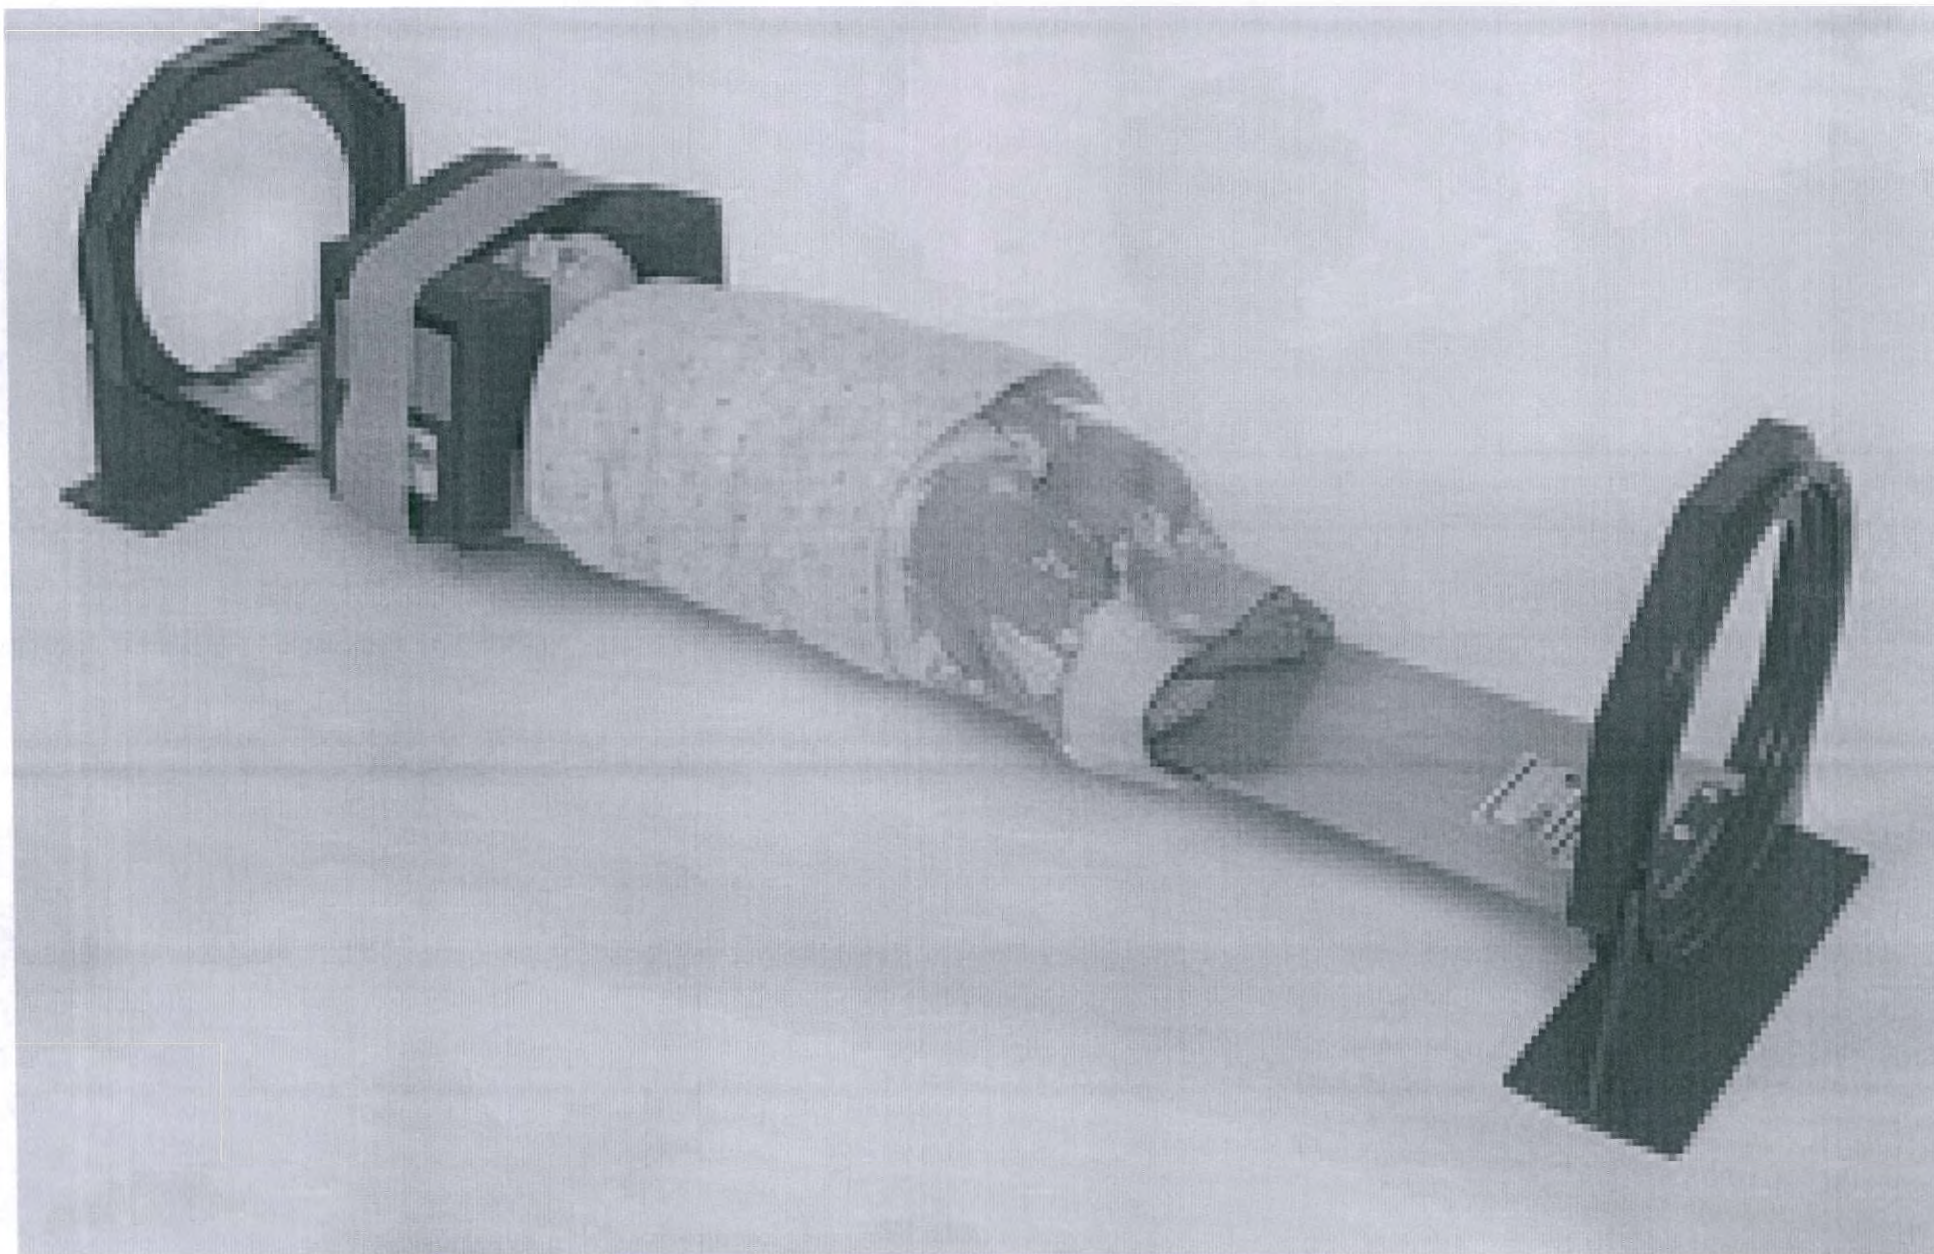


или «РЕНЕКС УРИД» производства фирмы ЗАО "РЕНЕКС", Российская Федерация; или производства ООО «С.П. Гелпик», Российская Федерация.




28. Машина для проявления медицинских рентгеновских пленок SRX-101A производства Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., Япония (РУ № РЗН 2013/1252).




III. Состав «УНИЭКСПЕРТ 3 плюс»:

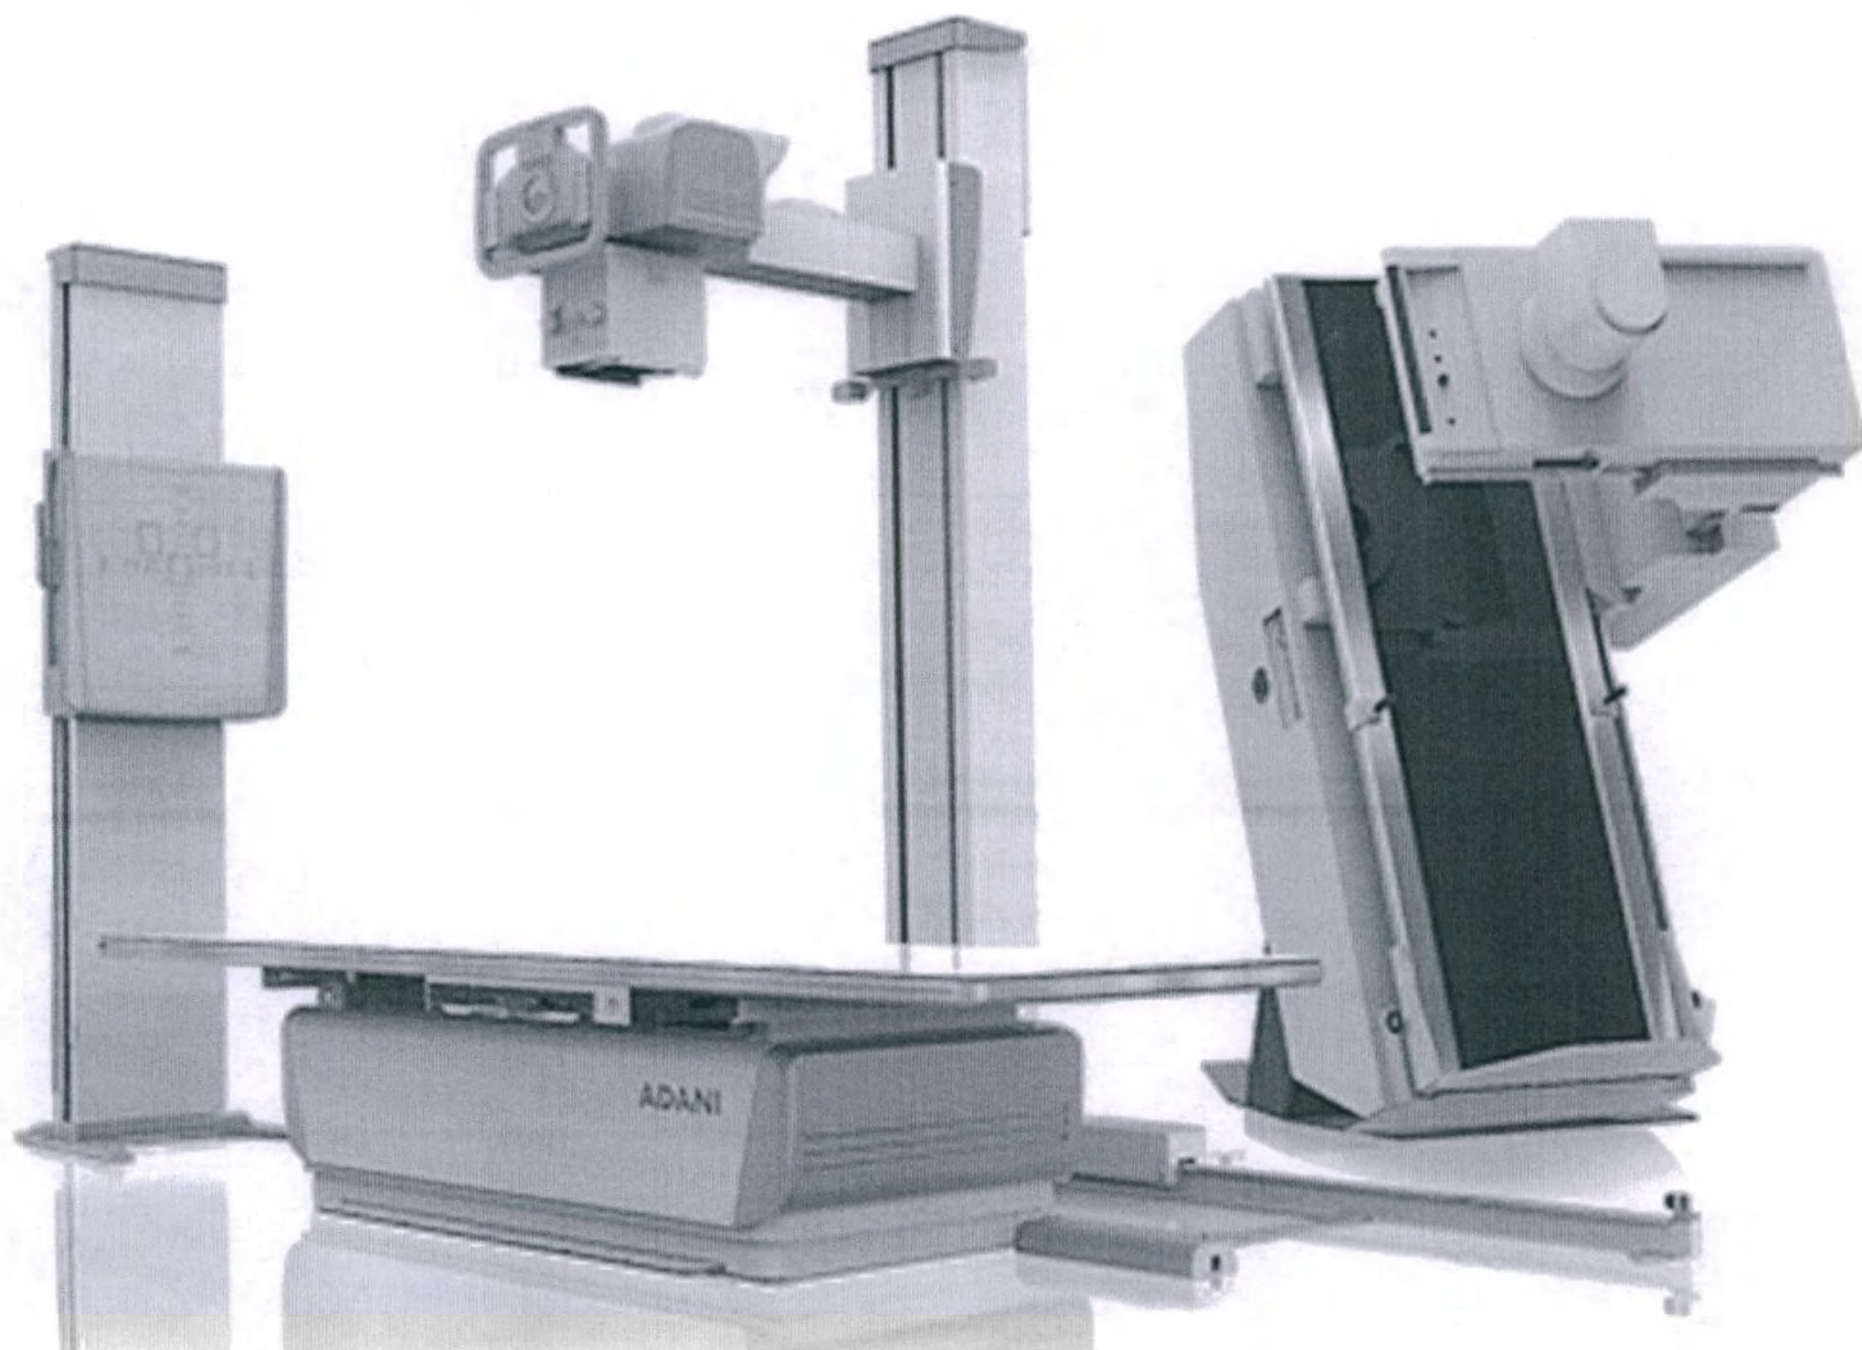


1. Стол рентгенографический IMX производства Imago Radiology S.r.l., Италия;

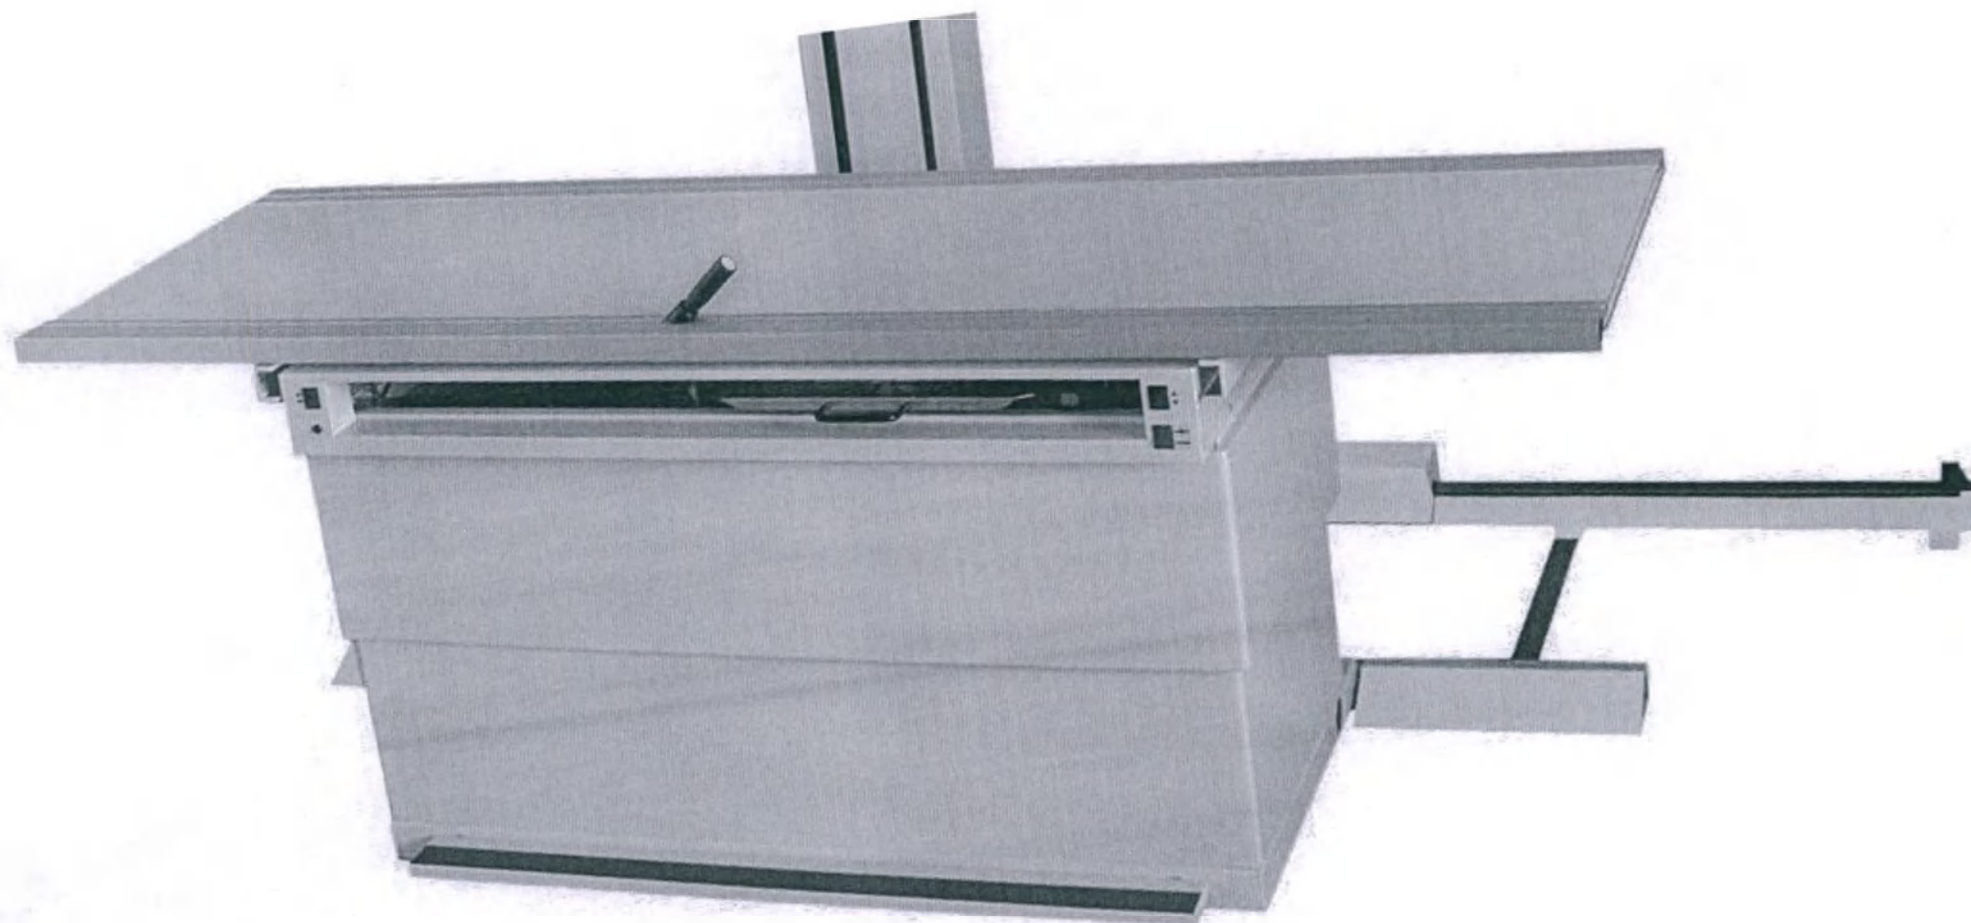


или Millenium производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания;

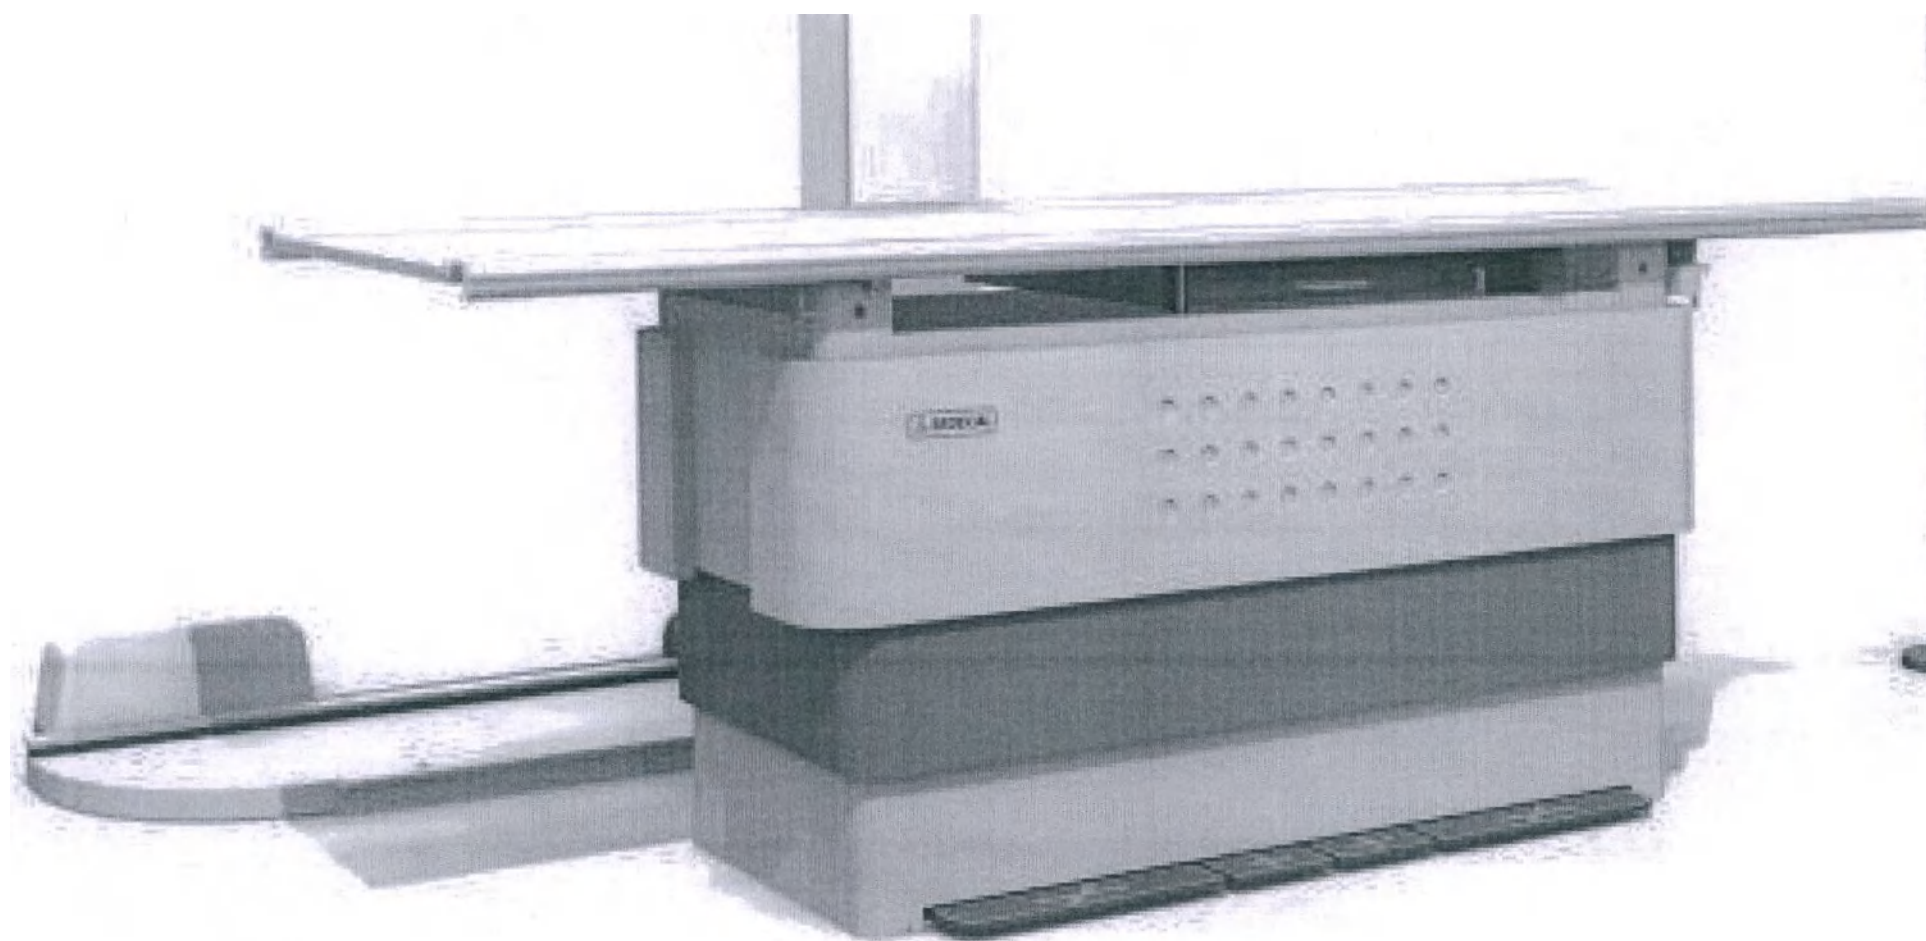


или МТО производства General Medical Merate SPA (GMM), Италия;

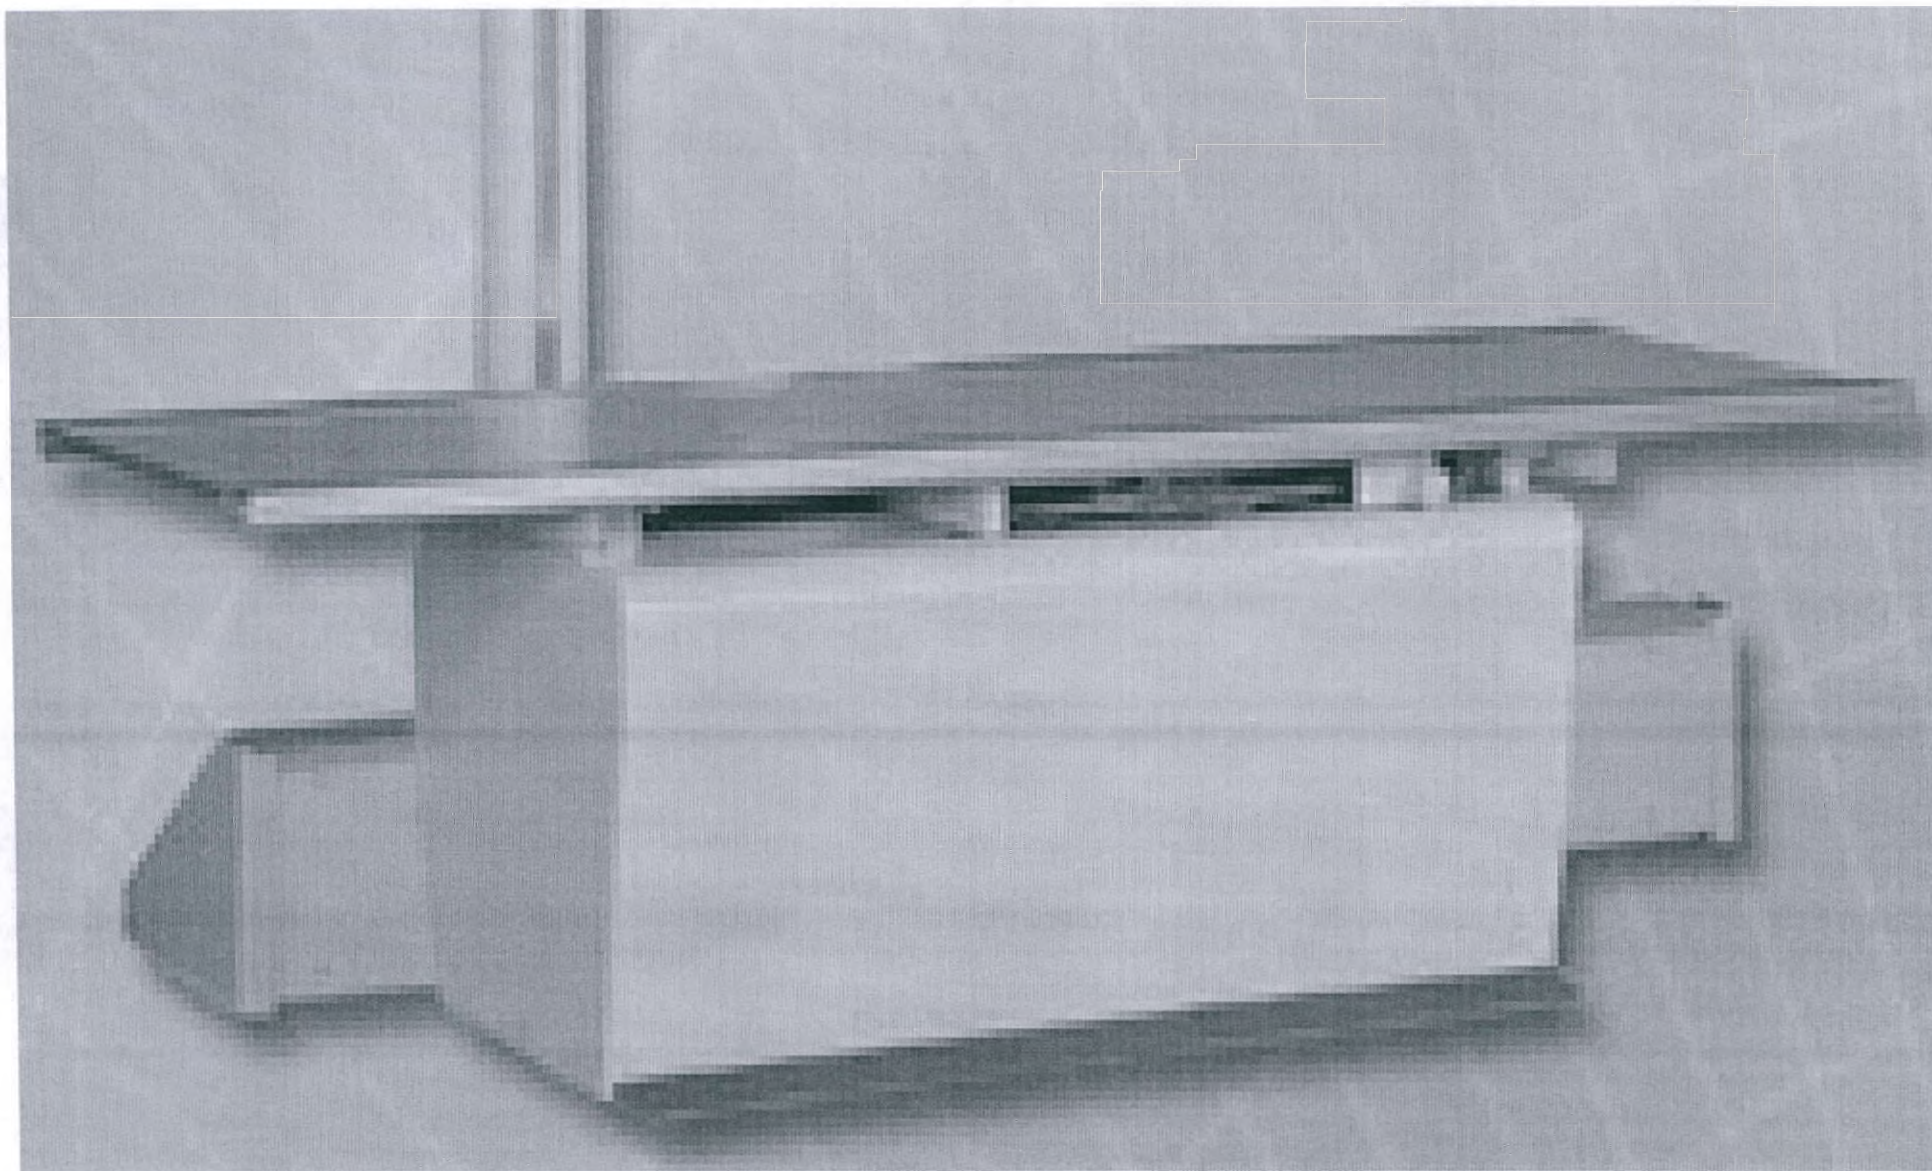


или производства Diagnostic Medical System Apelem, Франция;

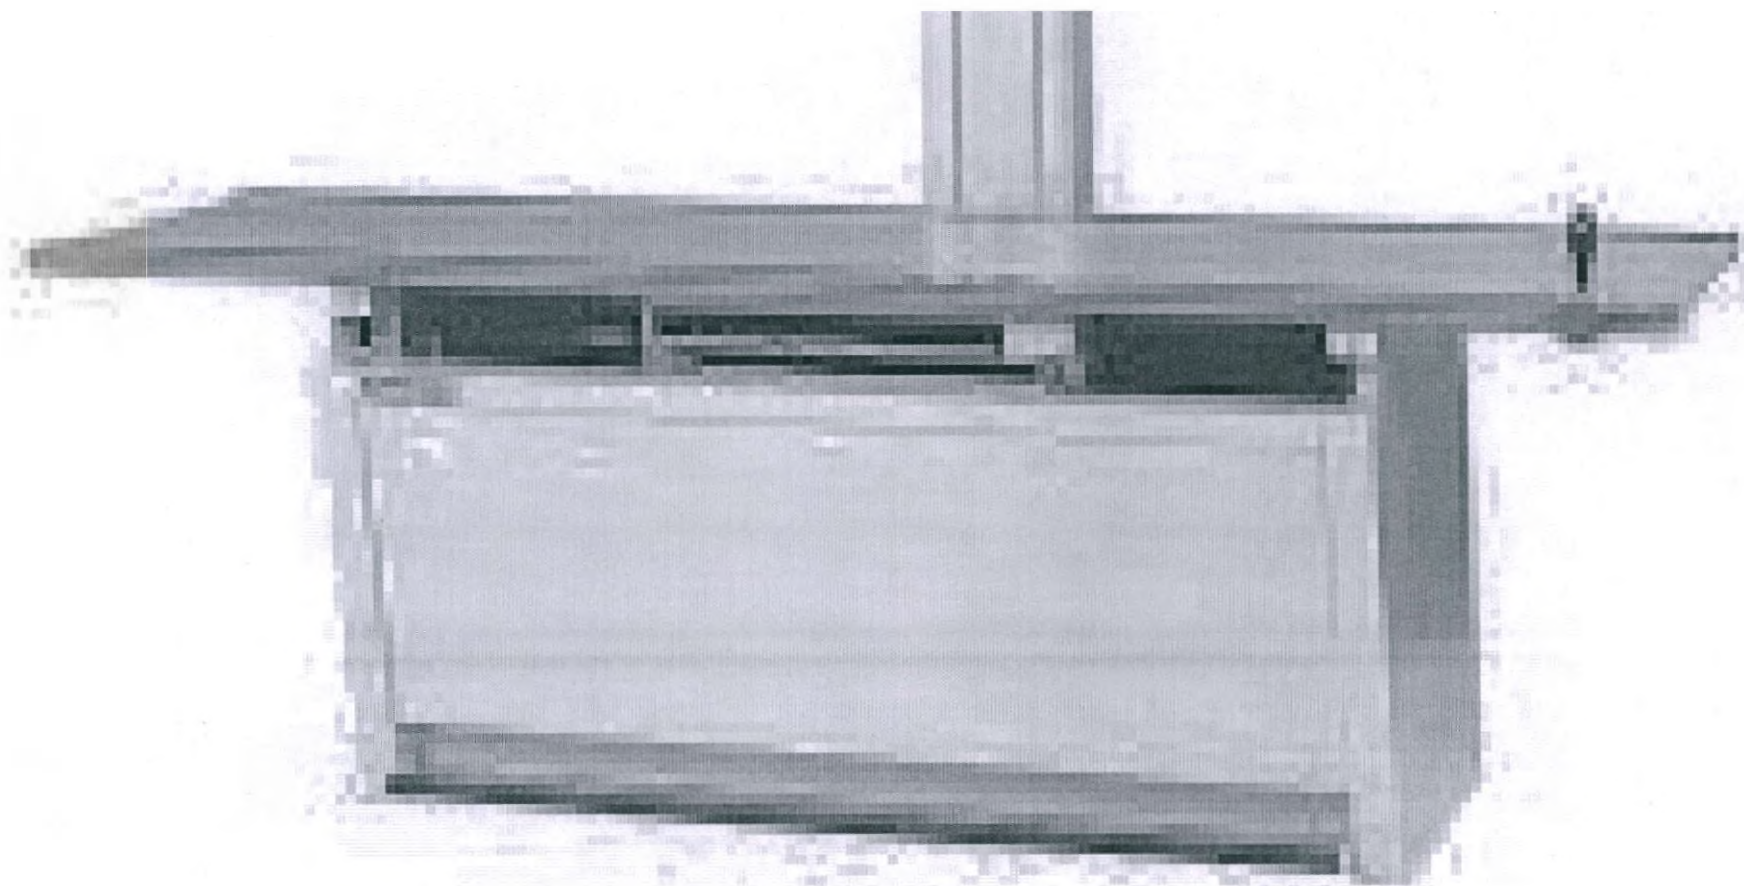

или АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

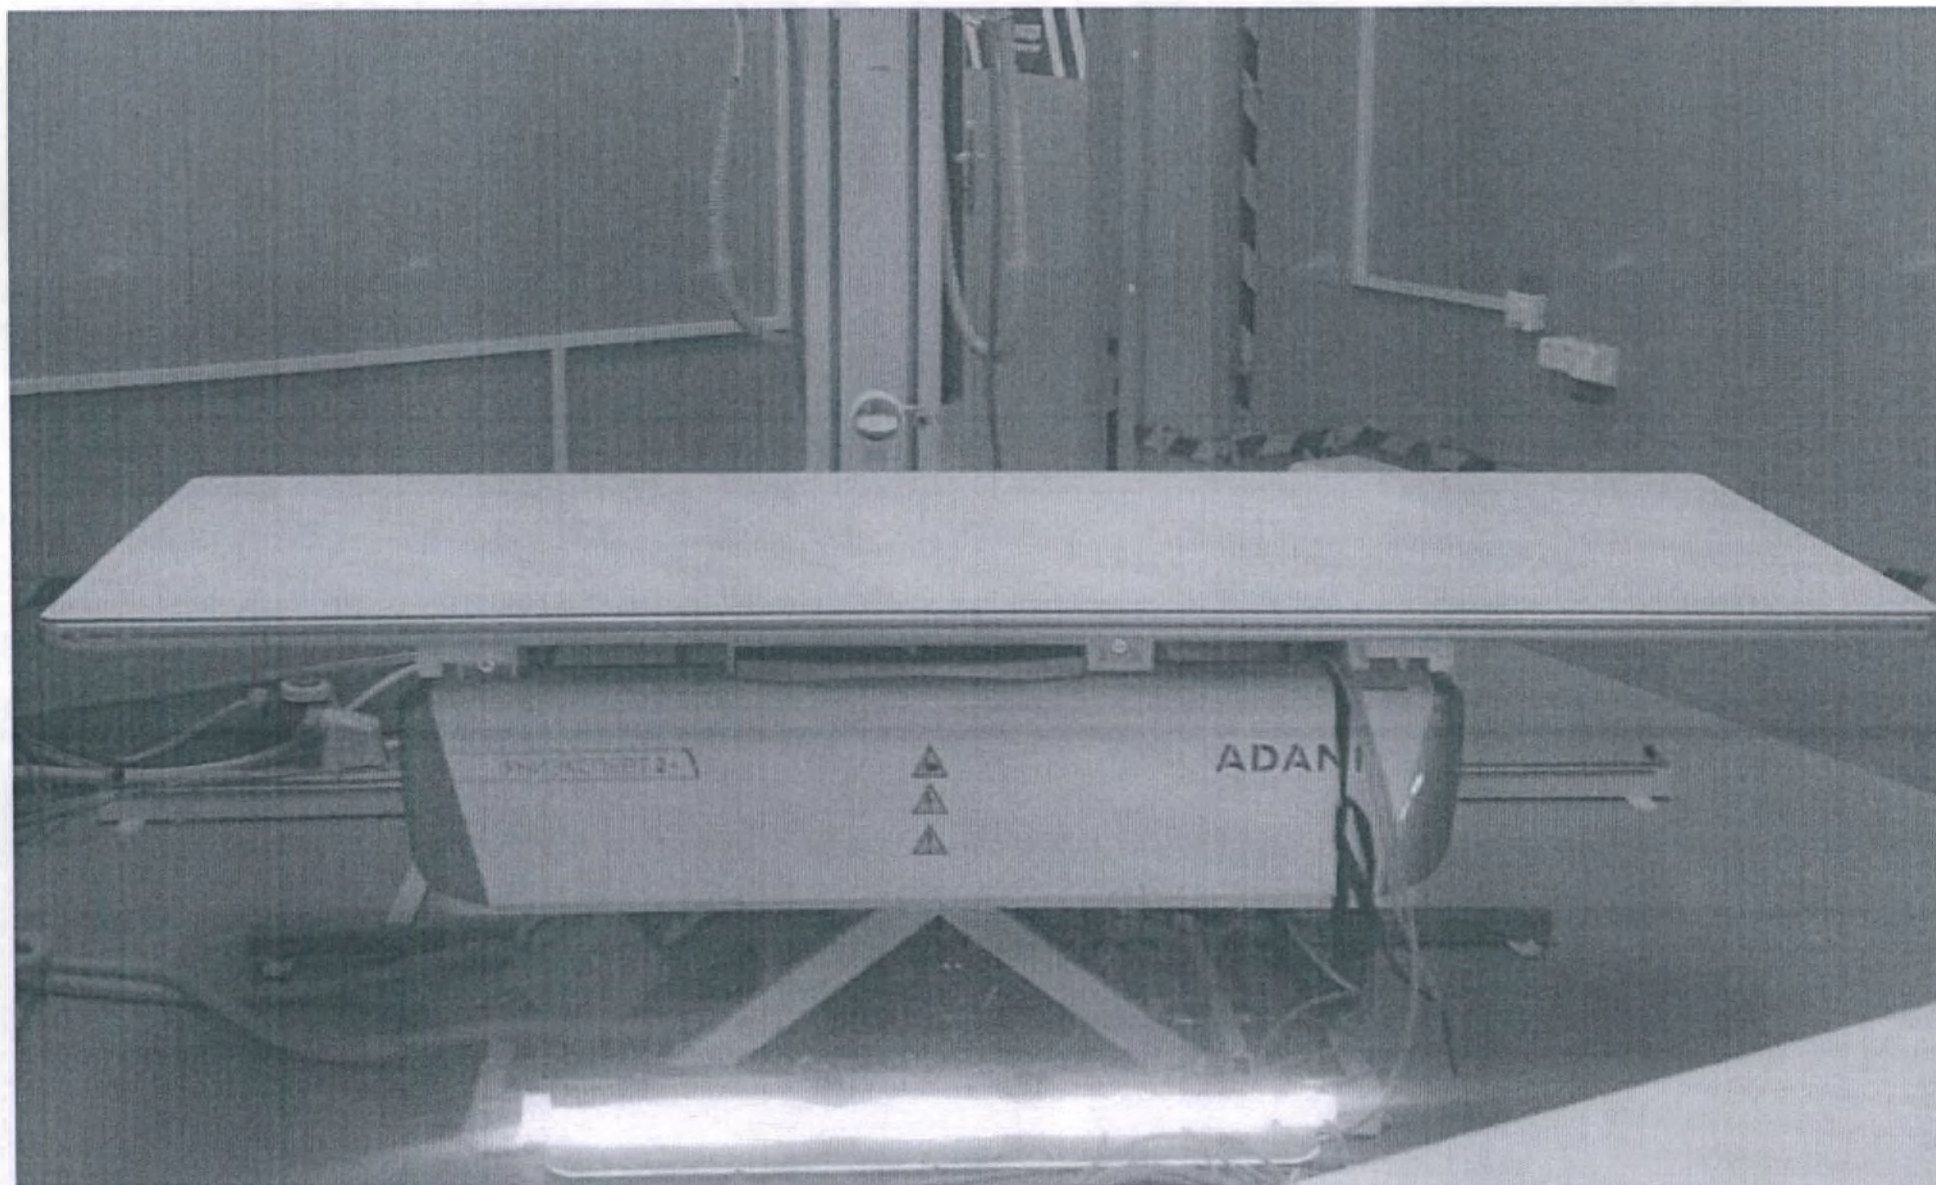


2. Рентгеновский излучатель Е; ЕХ производства Canon Medical System Corporation, Япония;

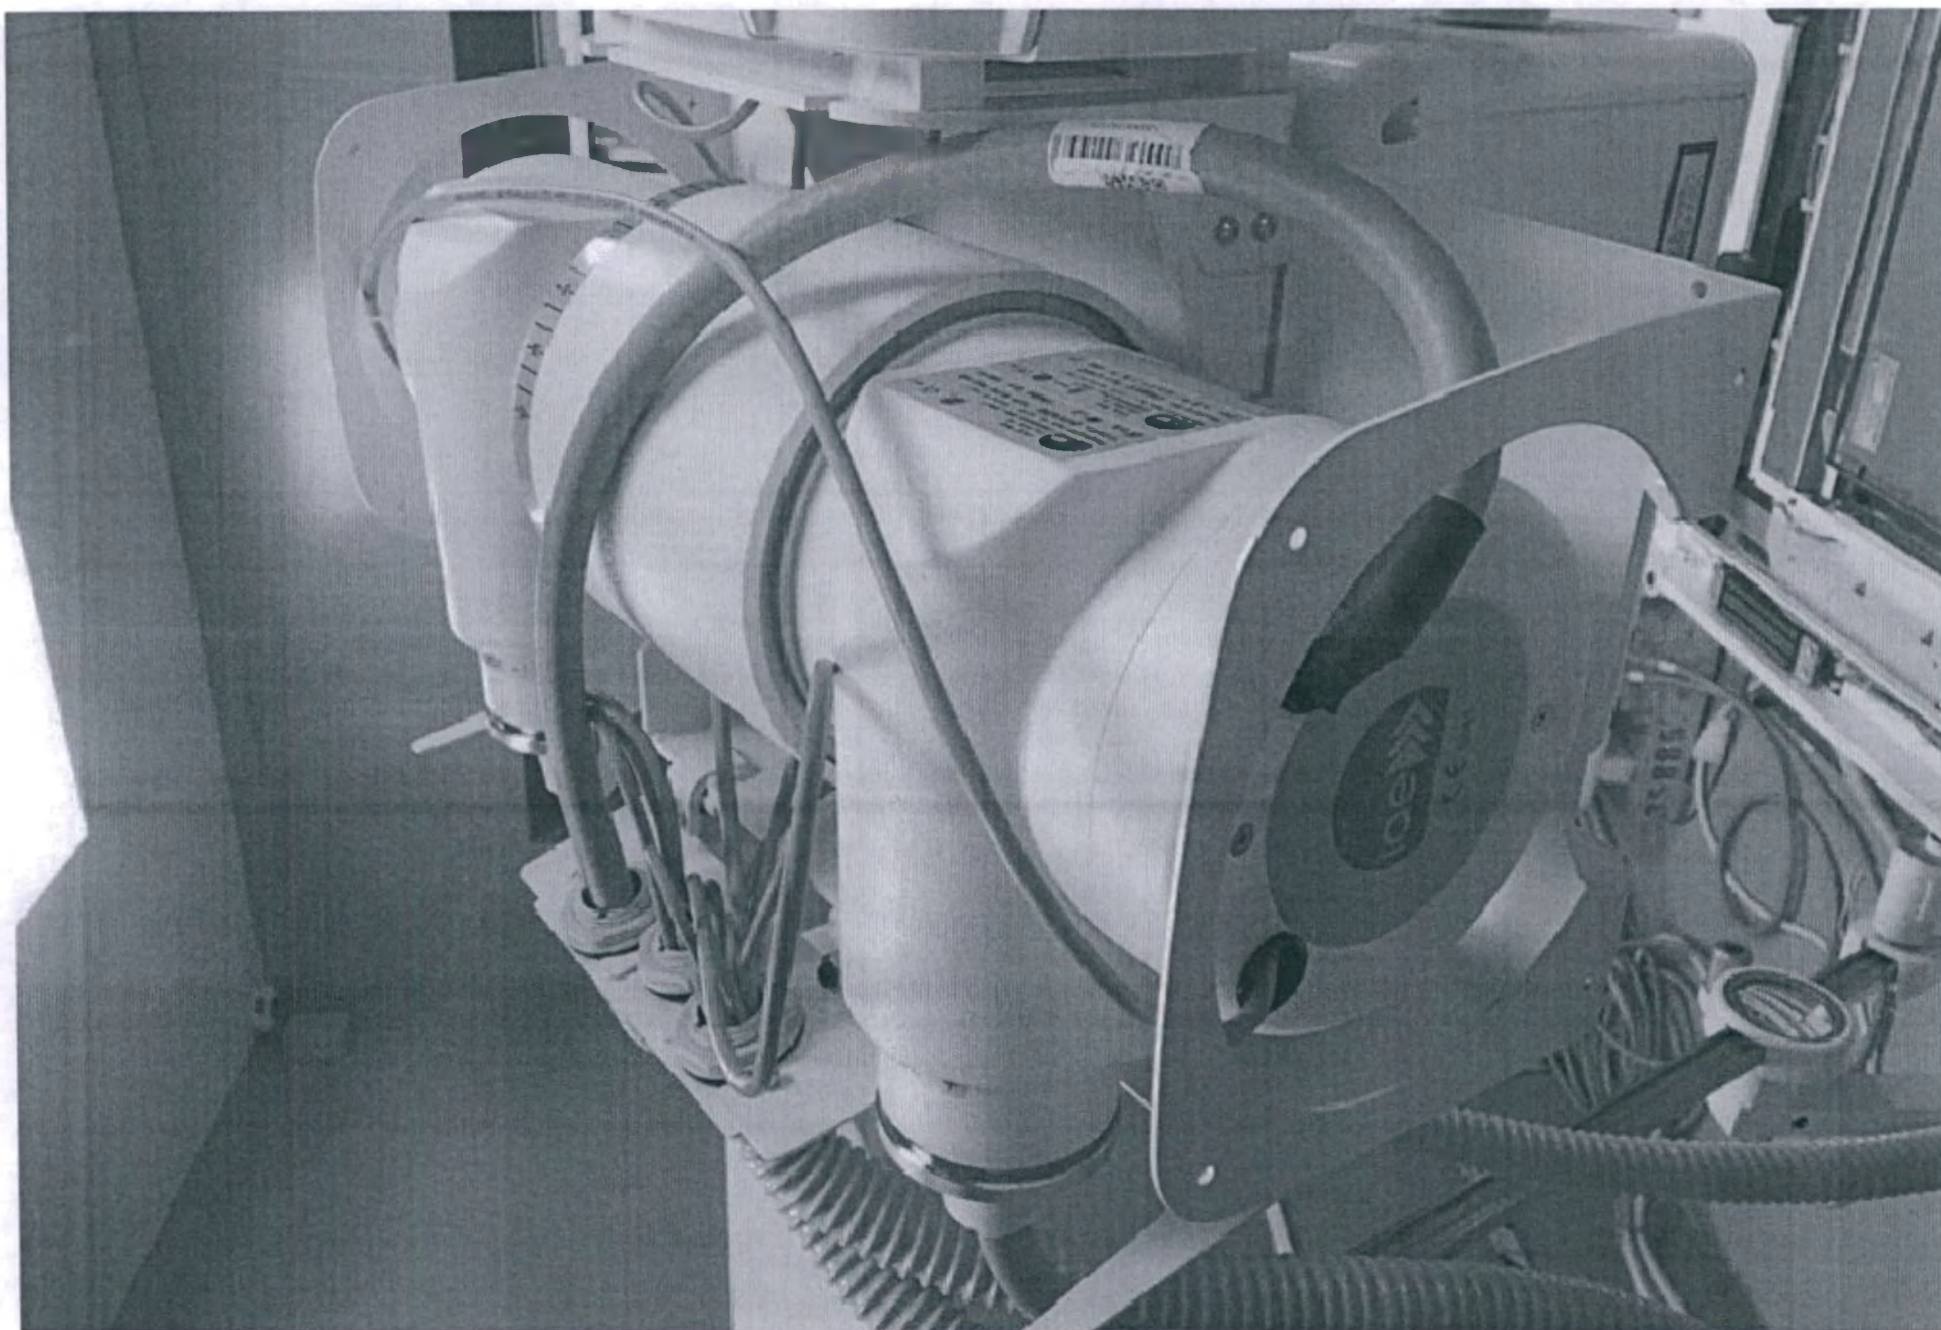


или X, RTM, RTC производства I.A.E Industria Applicazioni Elettroniche S.P.A., Италия;




или A; G; RAD; SG; Sapphire, Diamond, CGR производства Varex Imaging Corporation, США;

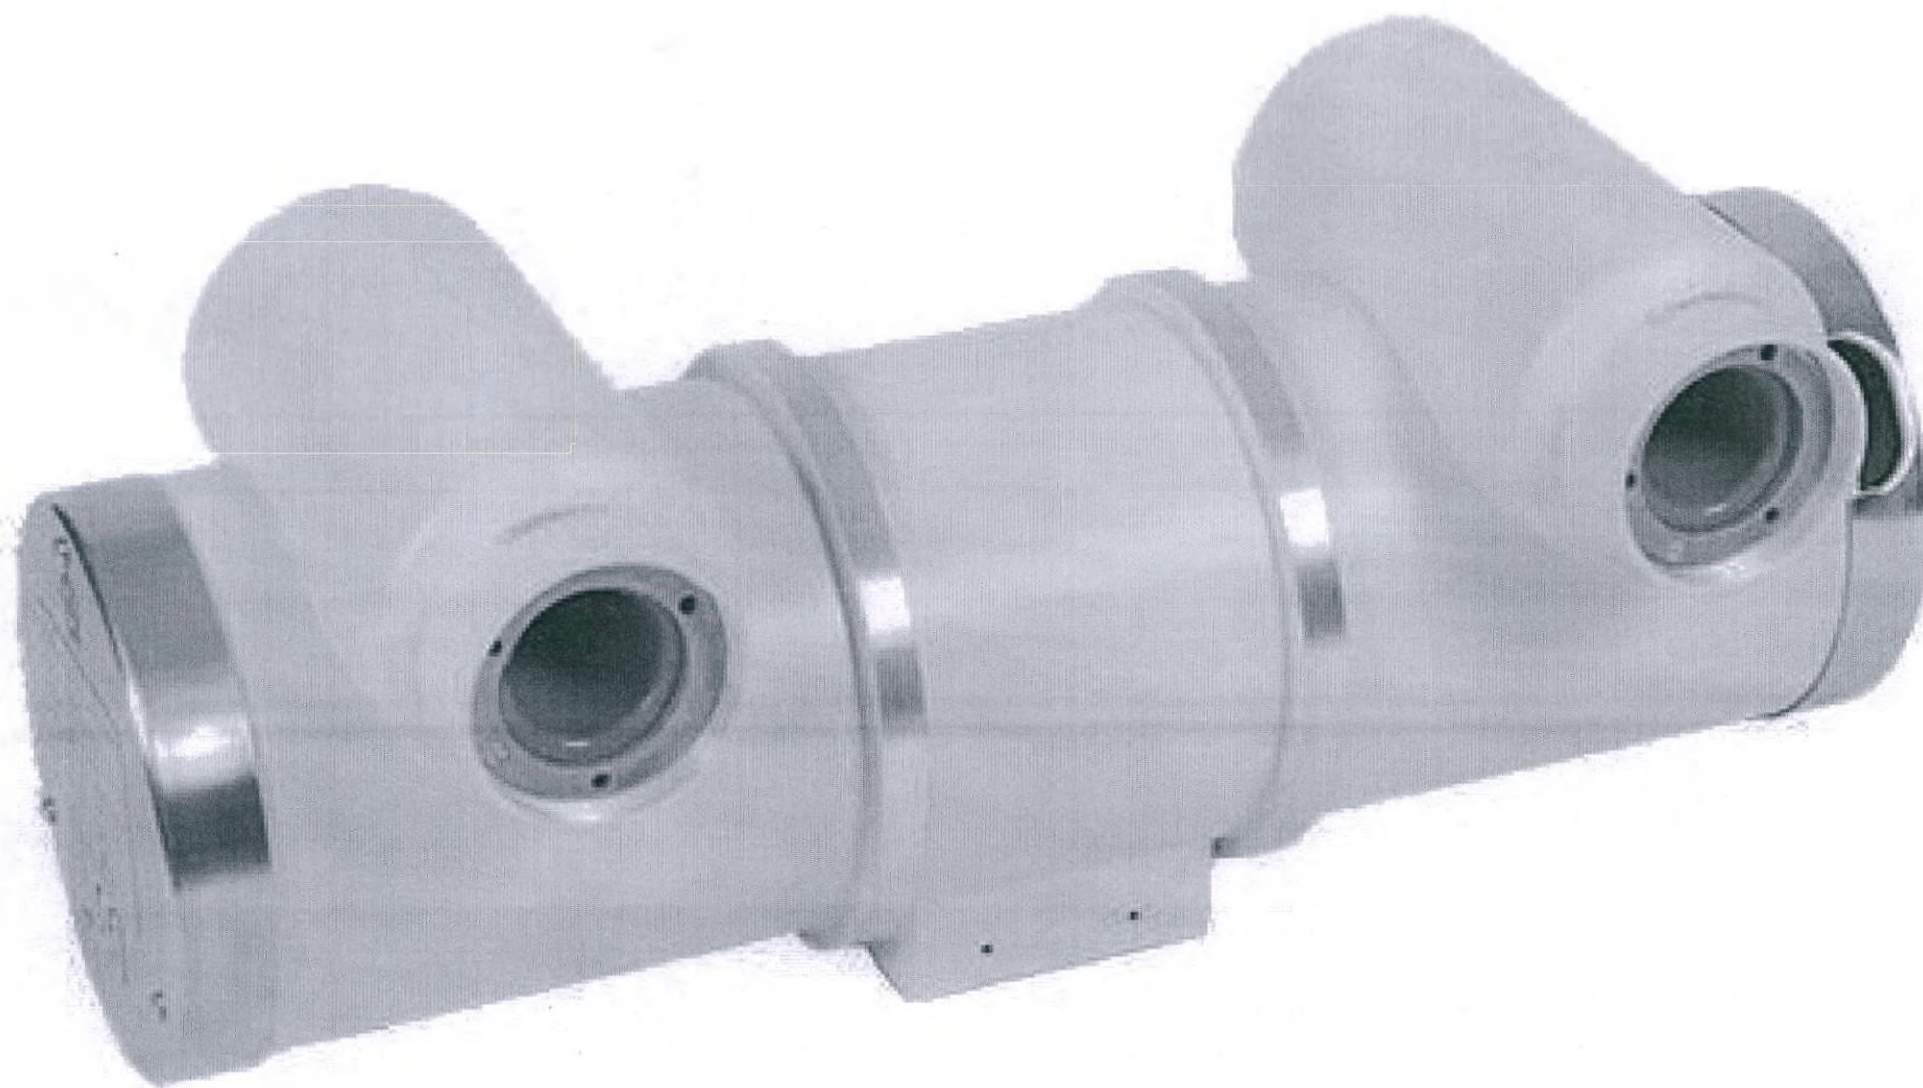


или Р 135/70; 135/30R; 125/10/20 CR производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

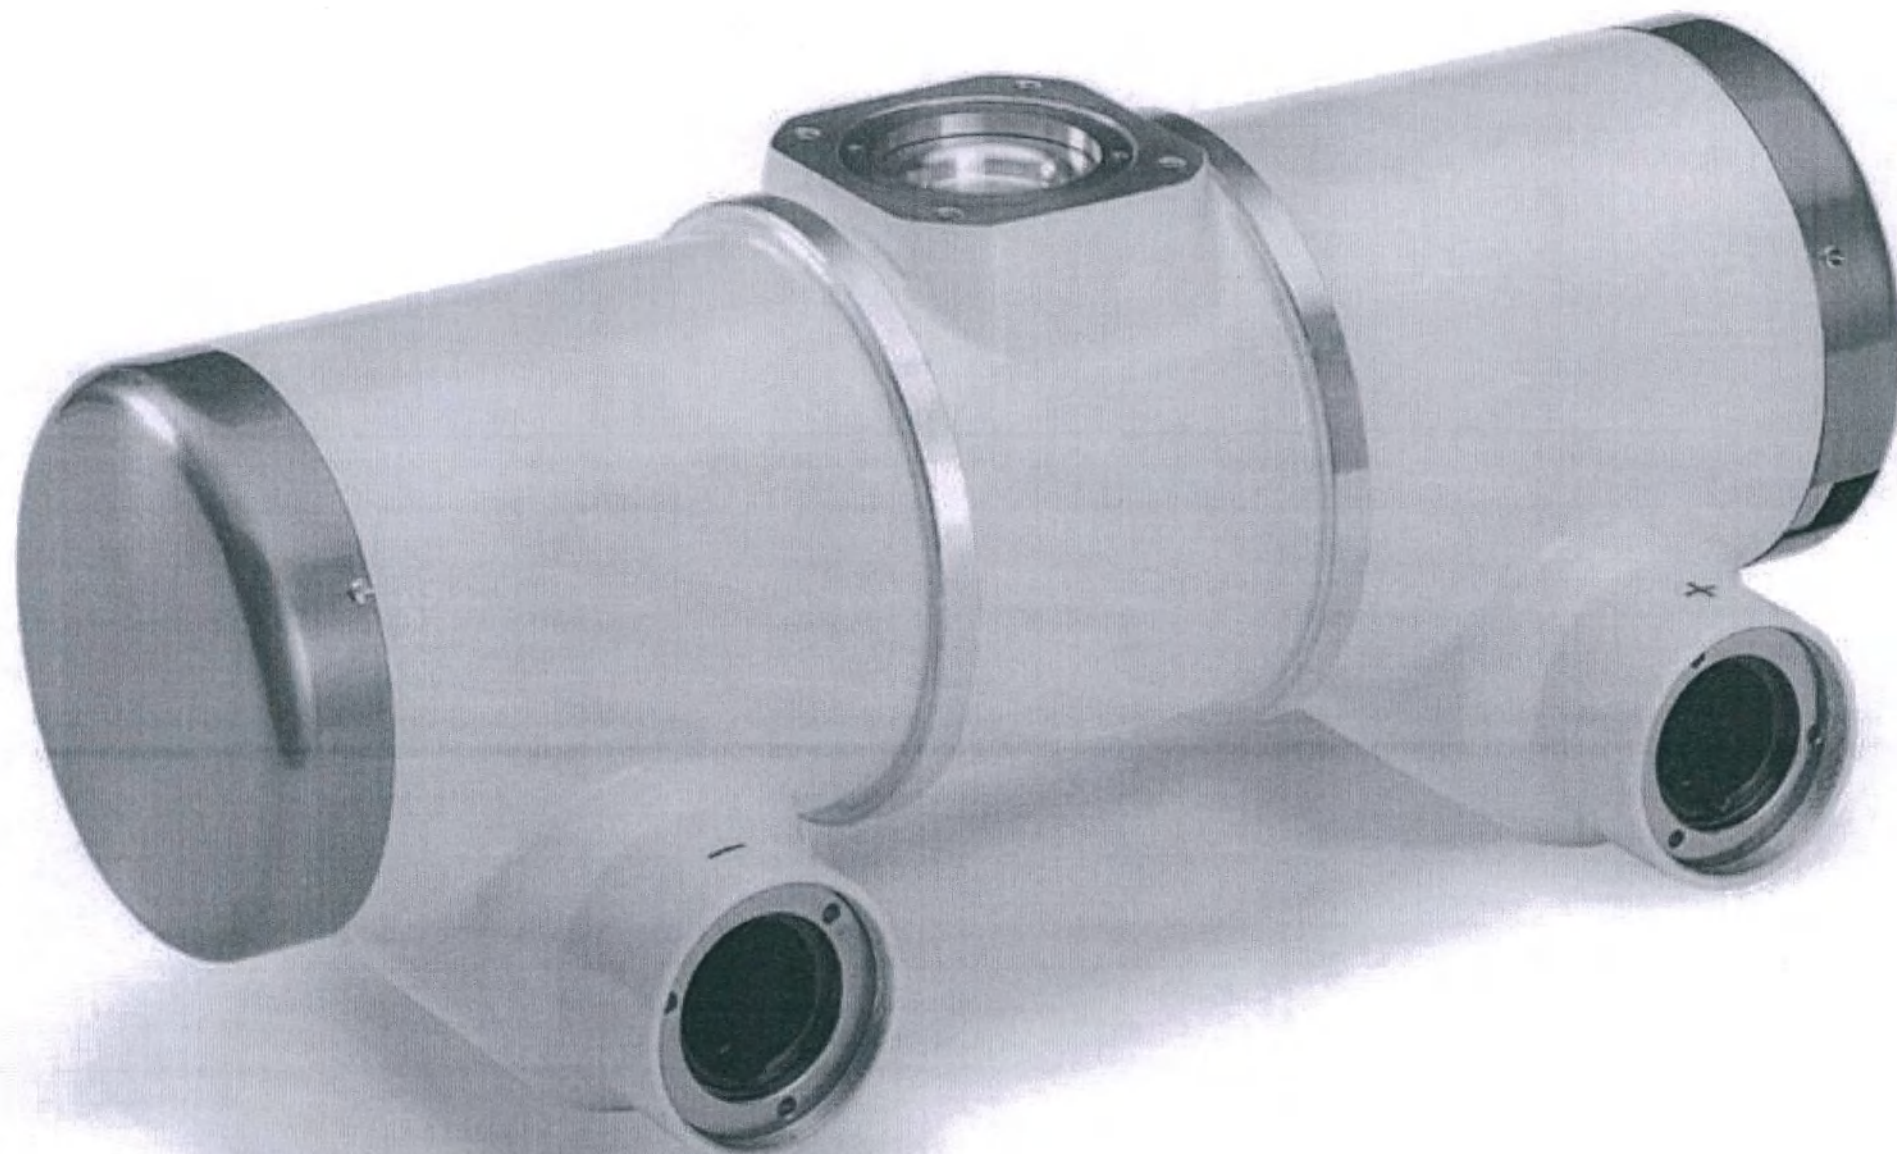


3. Кабели высоковольтные Cable Assy производства Varex Imaging Corporation, Филиппины и Нидерланды;

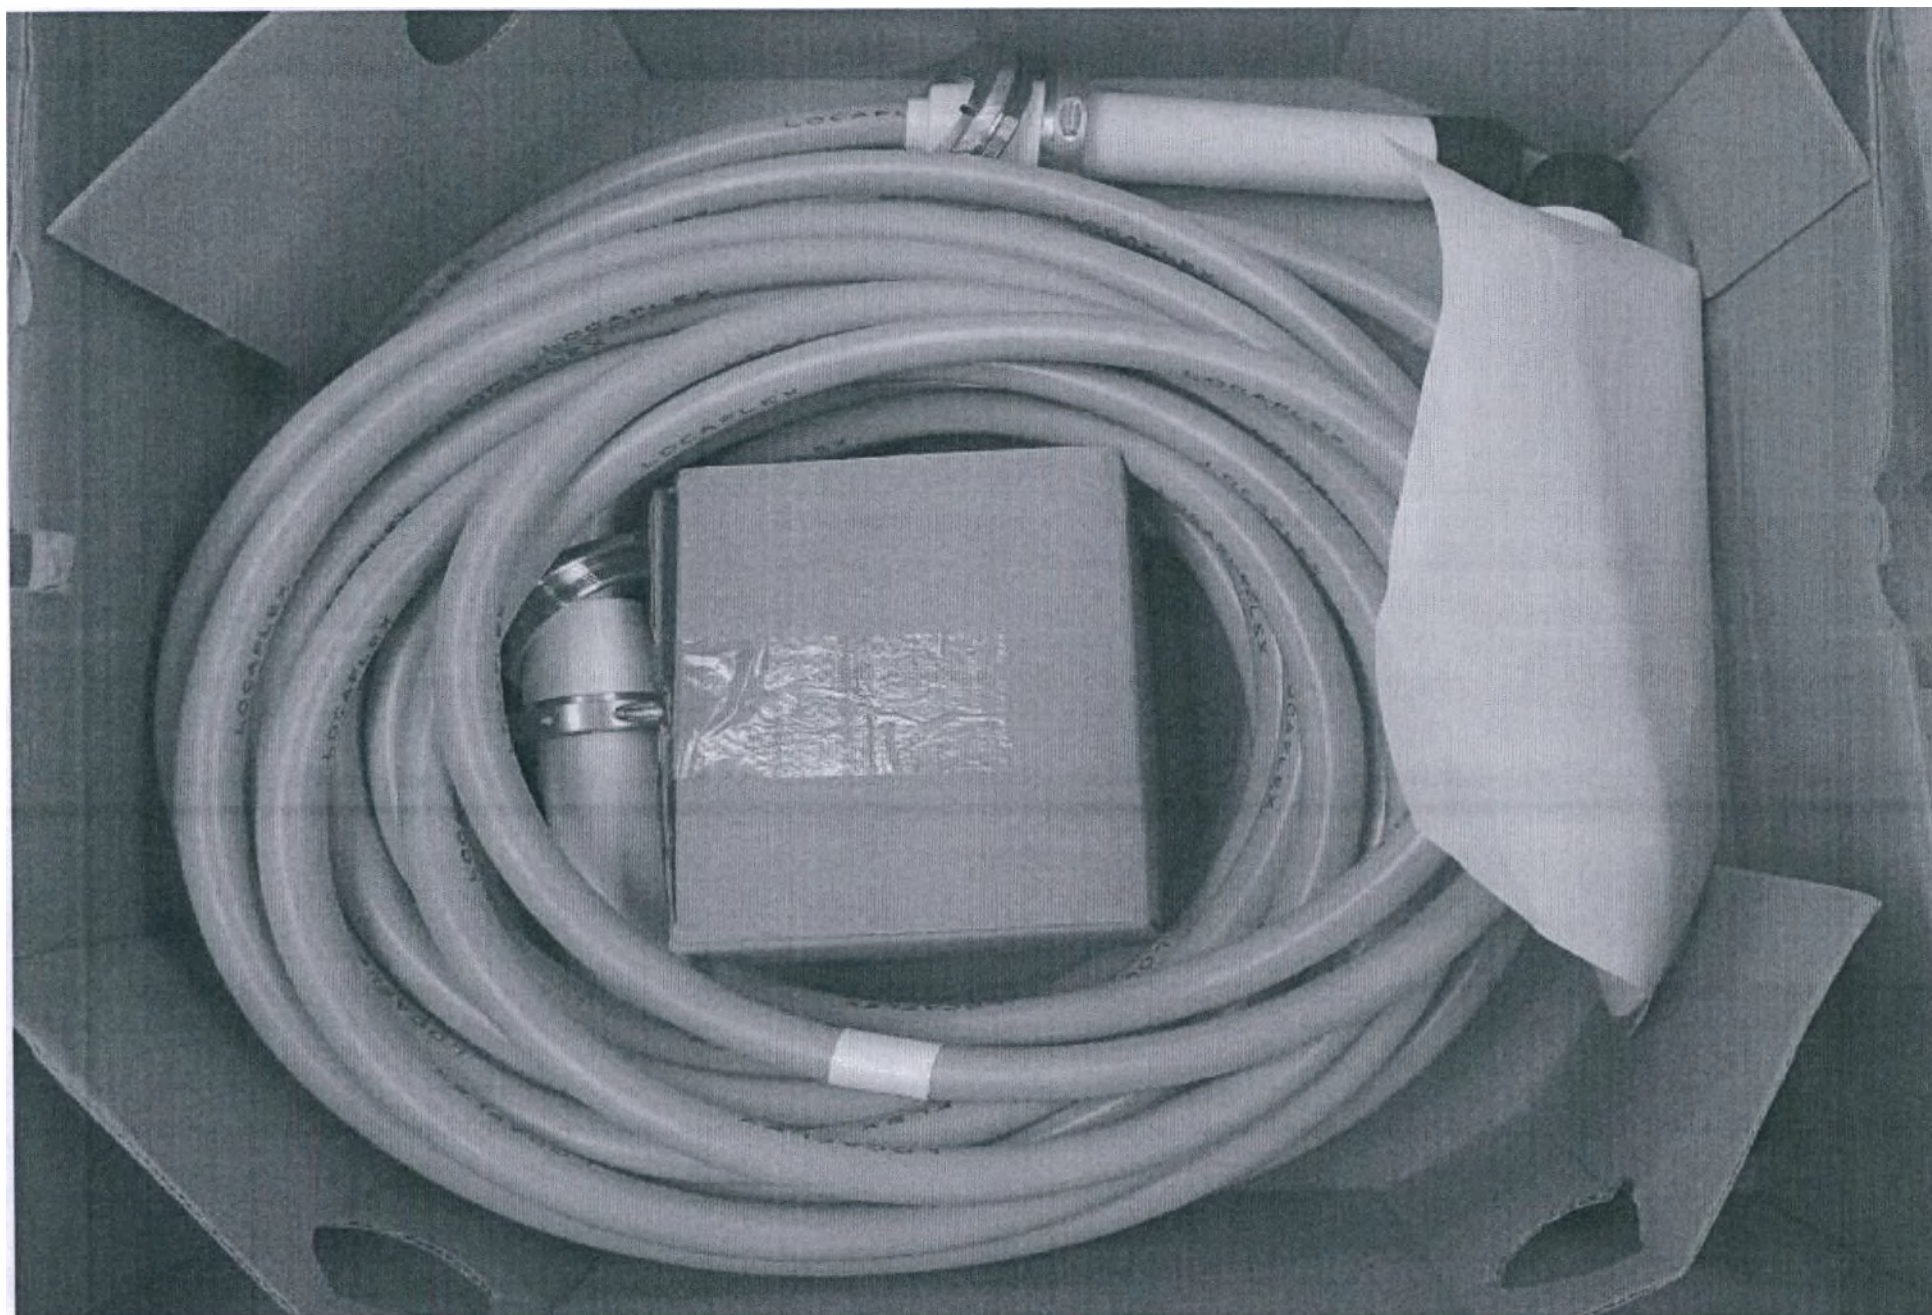

или Roesys HVC, производства Roesys GmbH, Германия; или производства Comet AG, Швейцария.

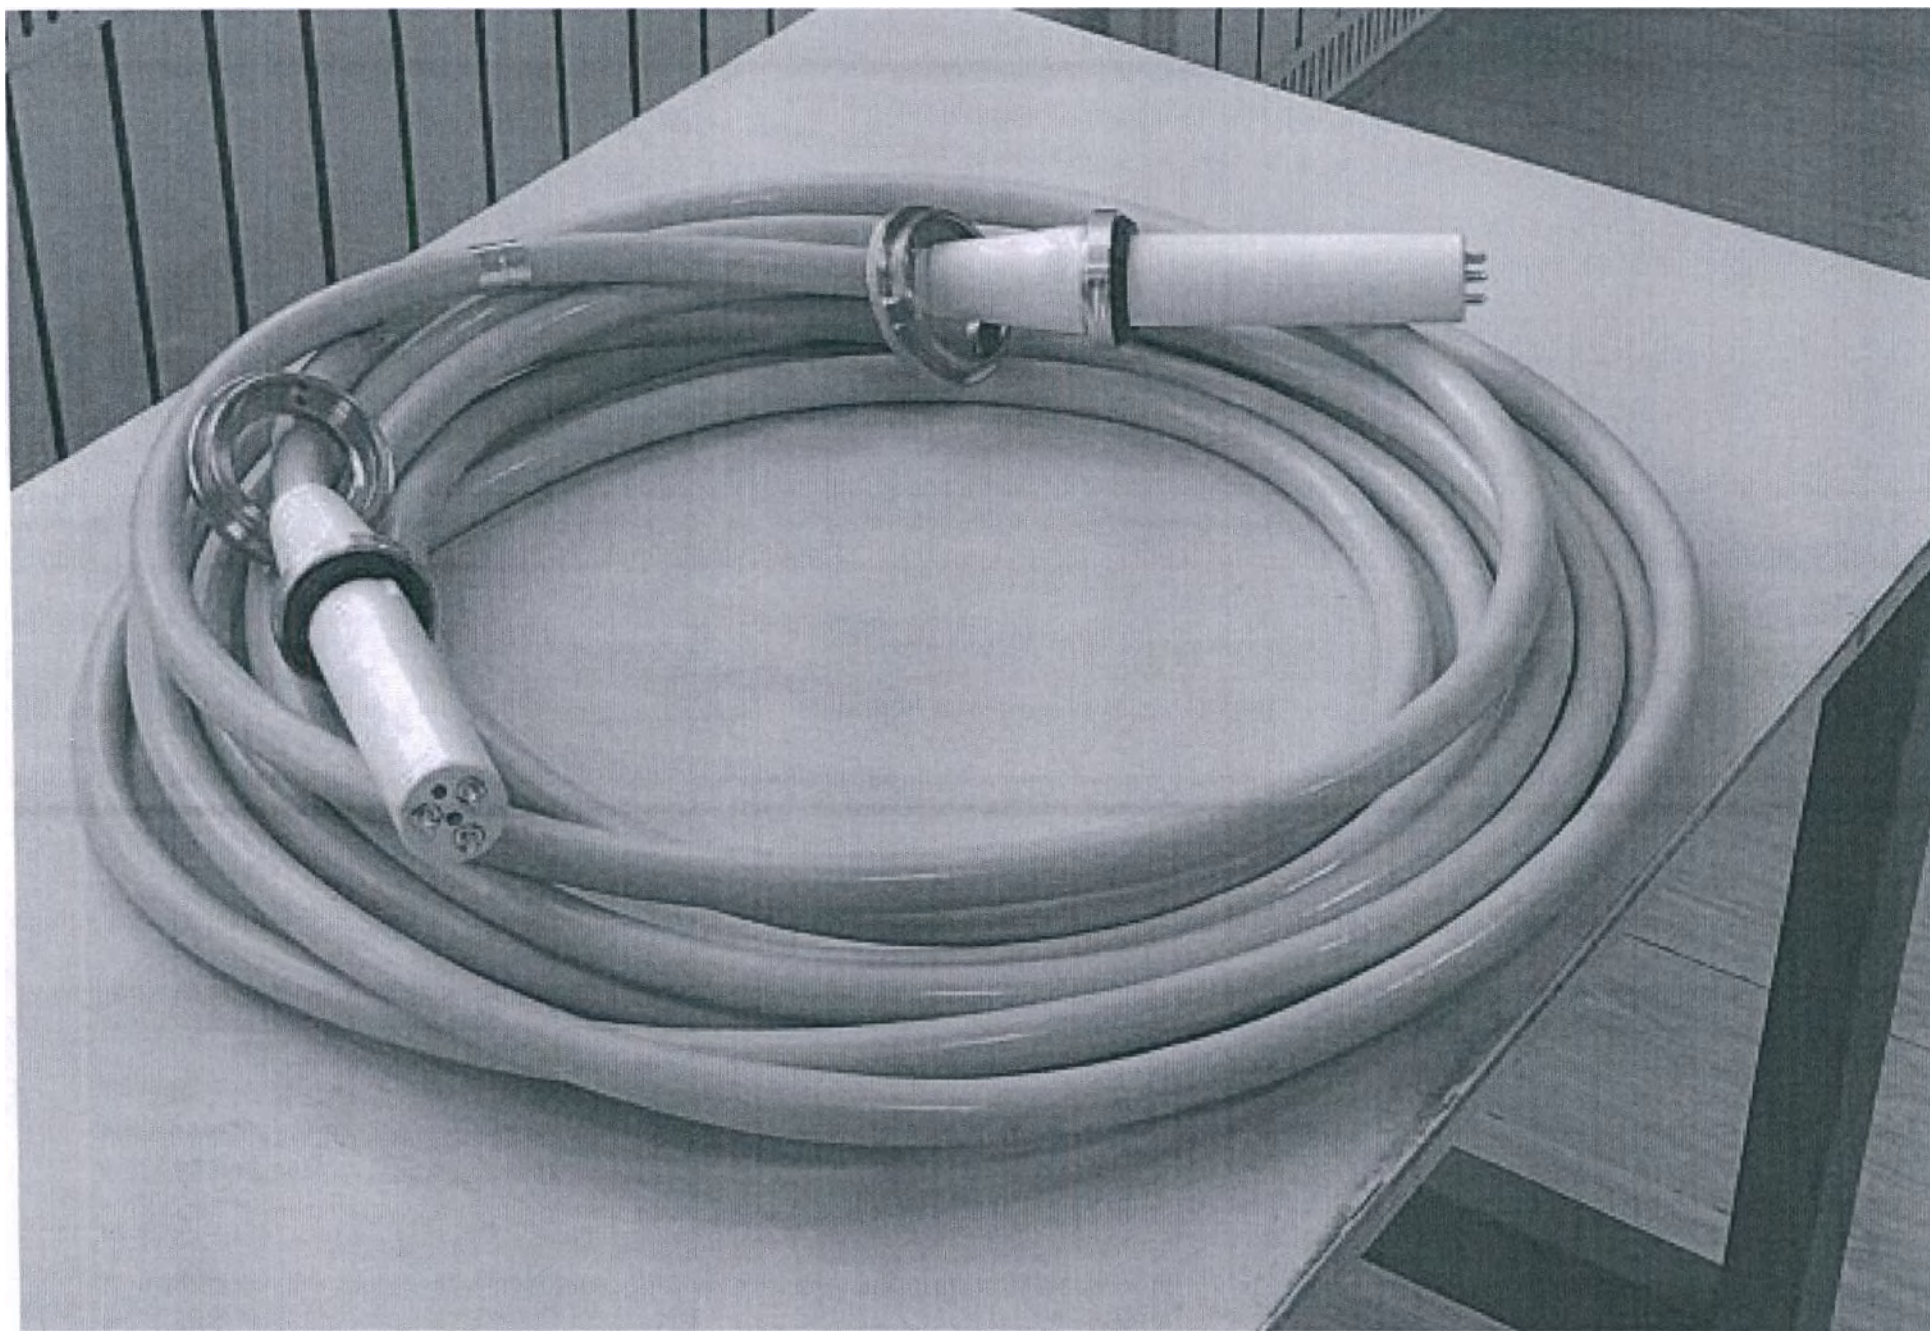


4. Колонна опорная для рентгеновского излучателя IMX производства Imago Radiology S.r.l. Италия;

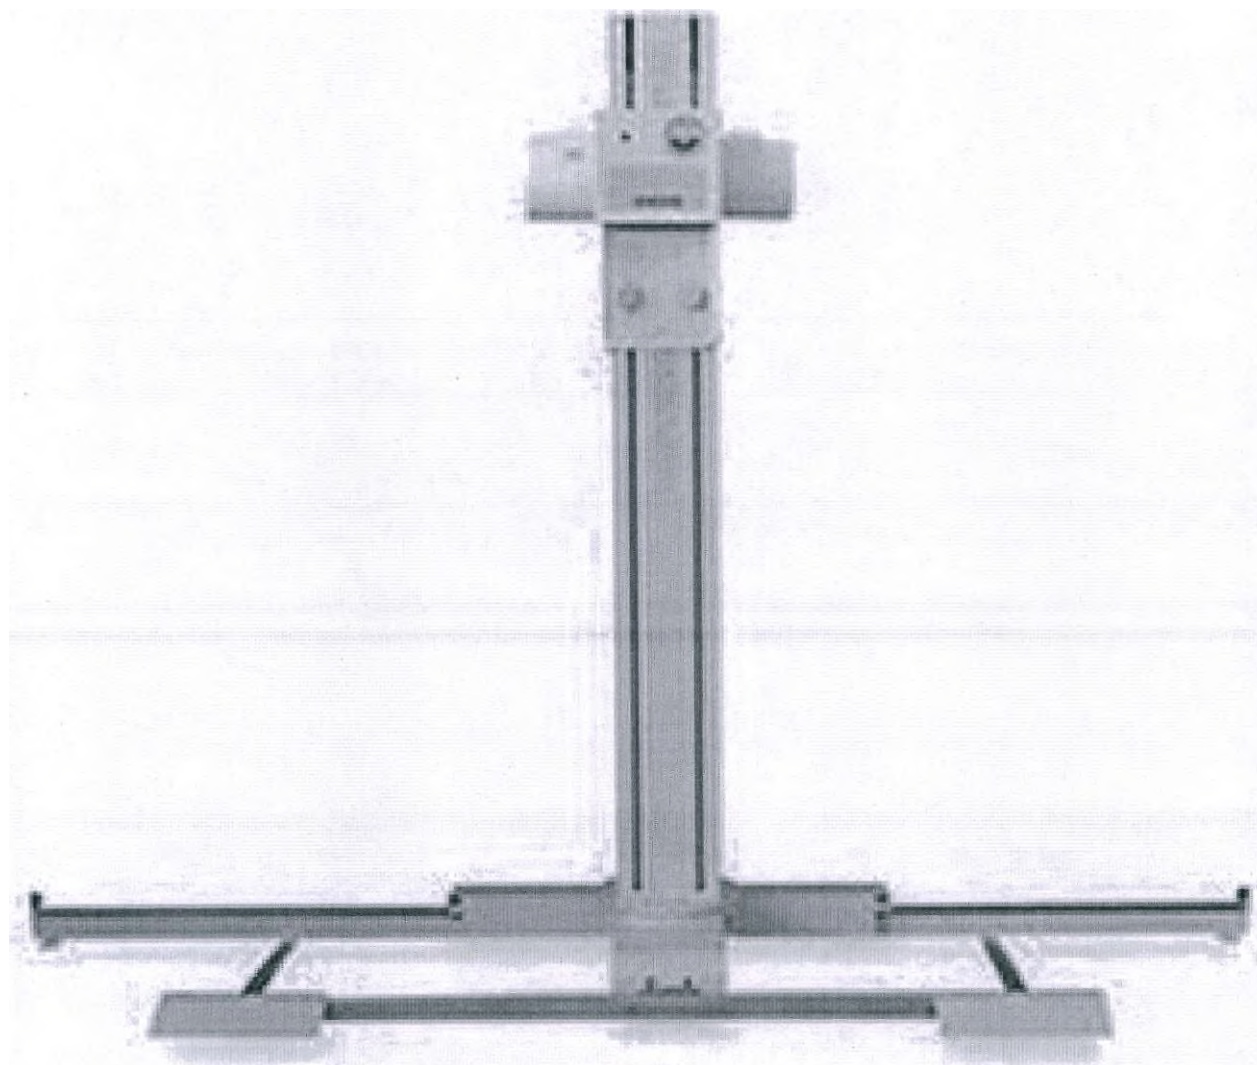


или Millenium производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания;




или МСР производства General Medical Merate SPA (GMM), Италия;

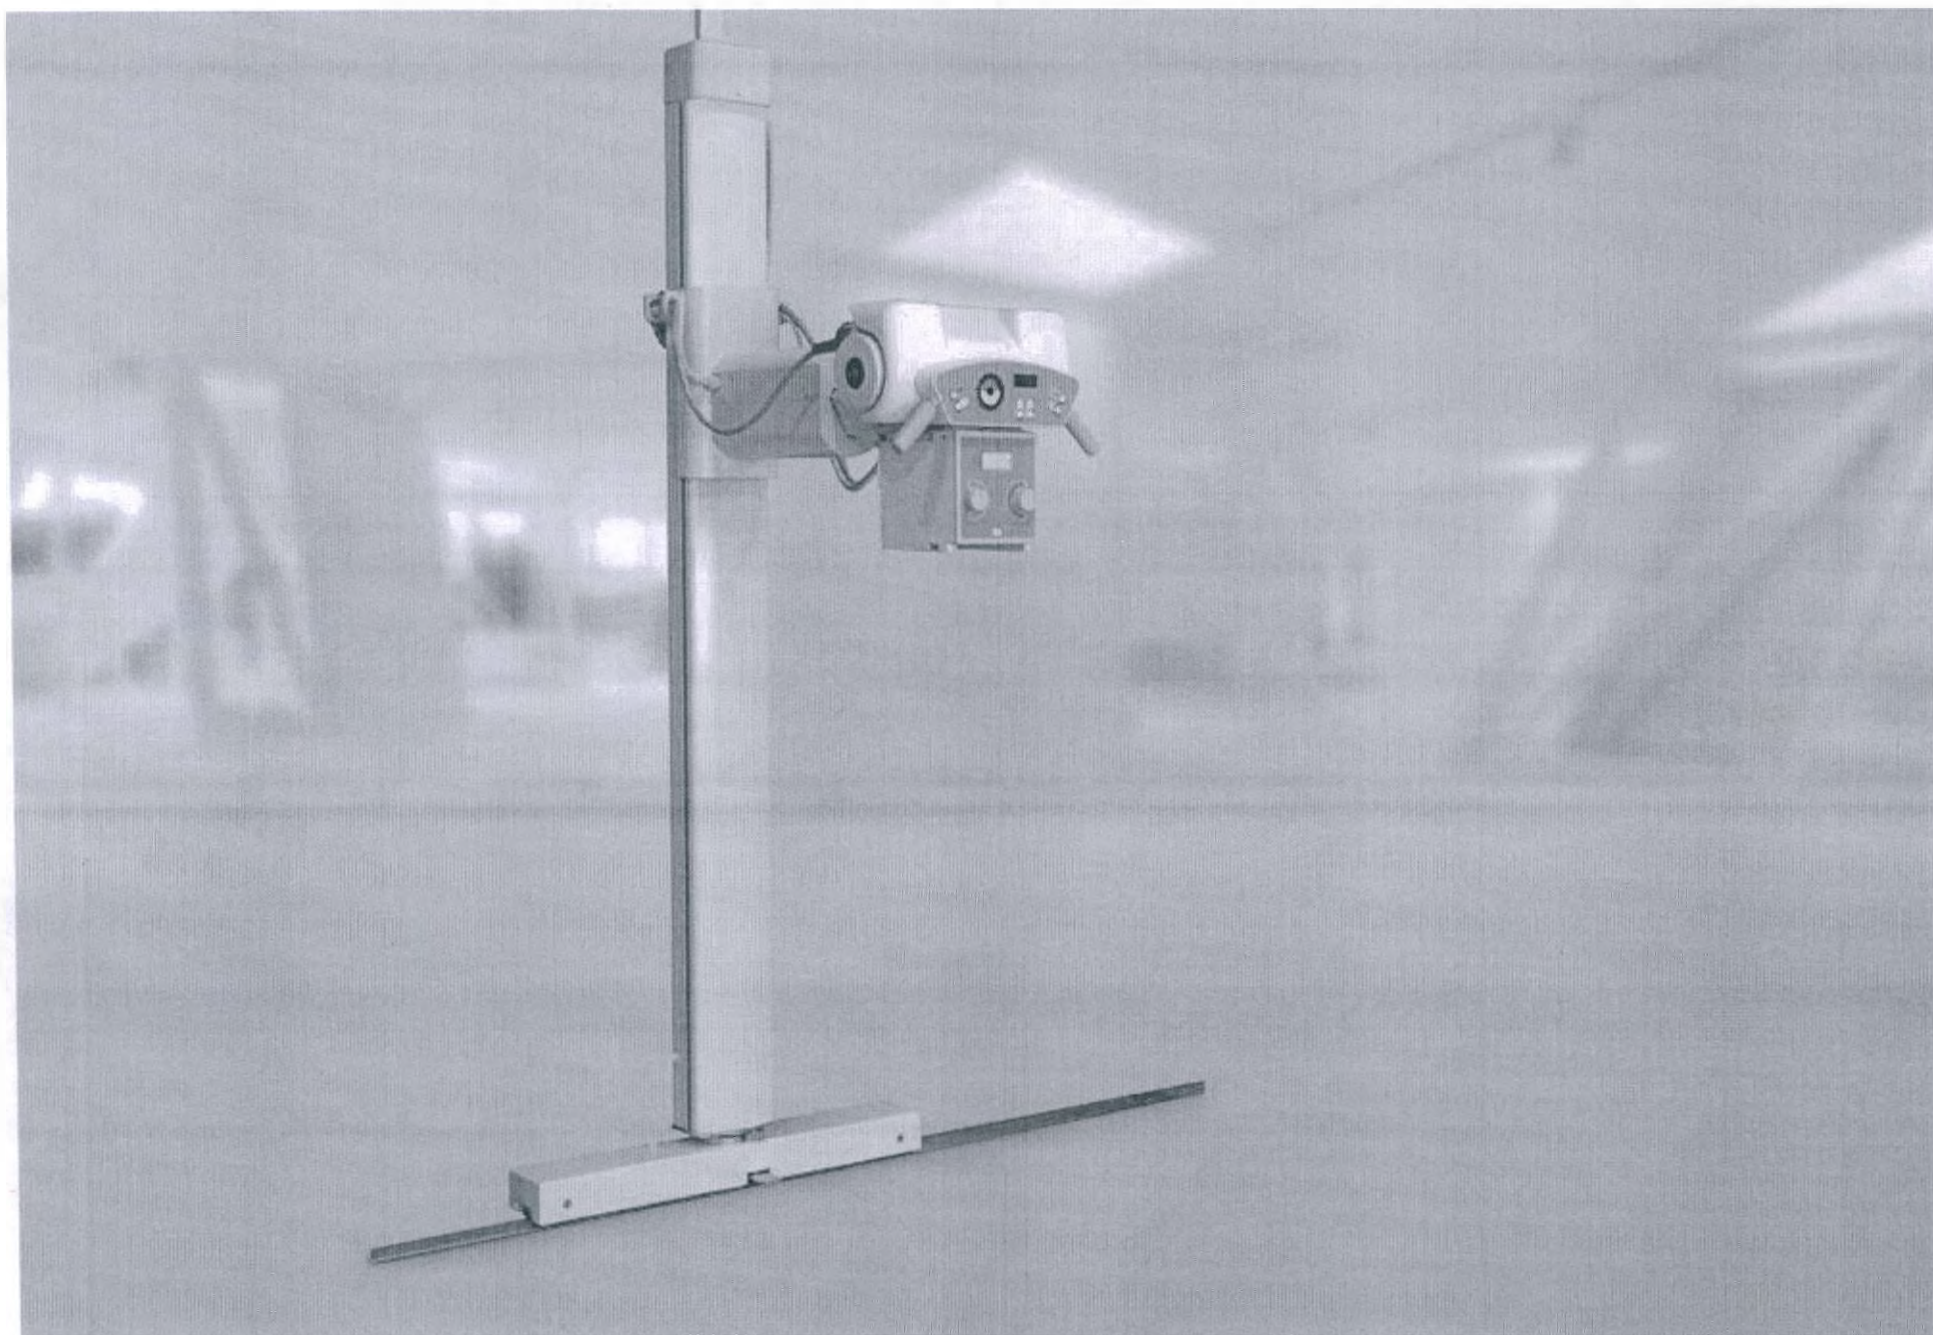


или АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

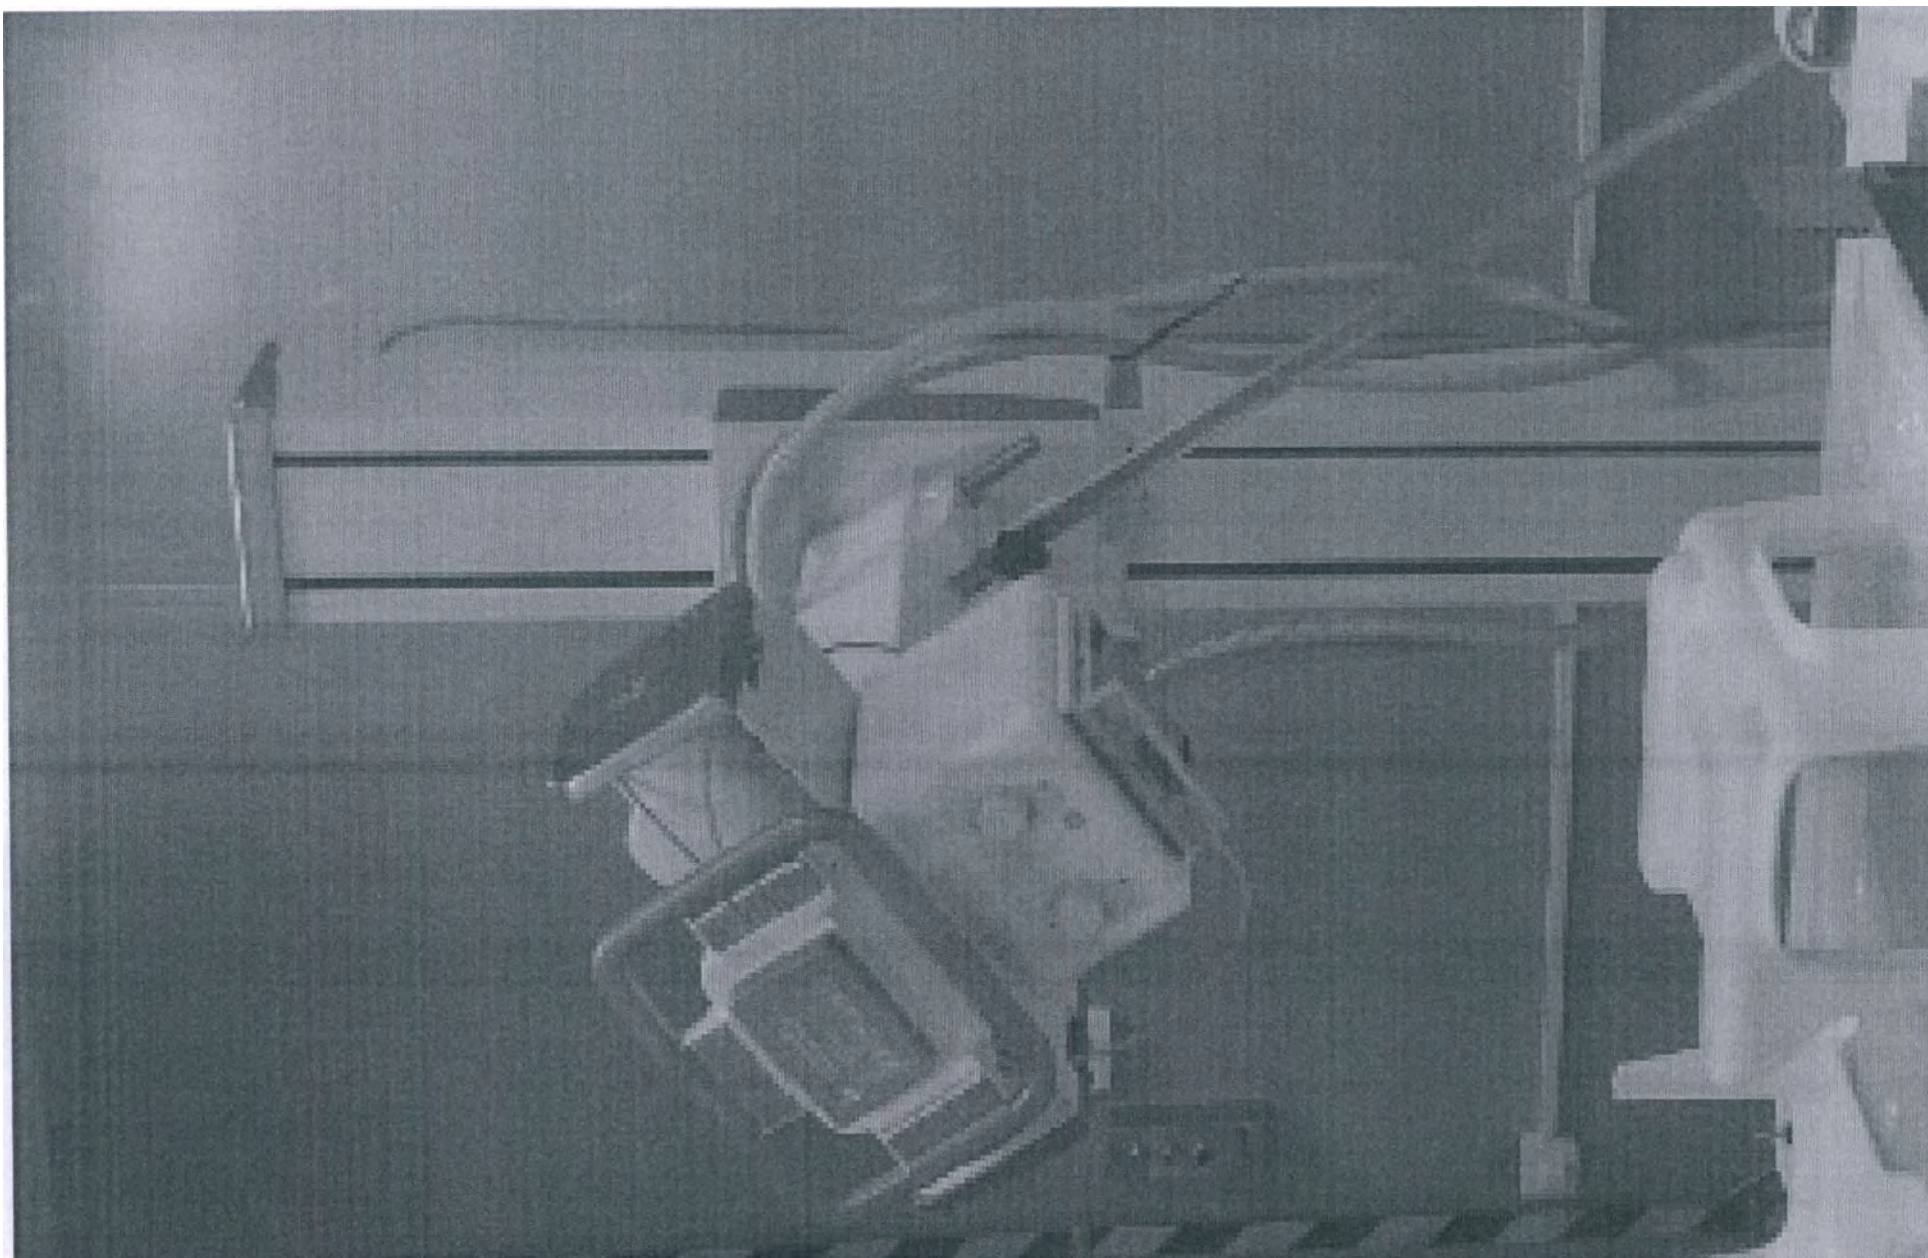


или производства Diagnostic Medical System Apelem, Франция;

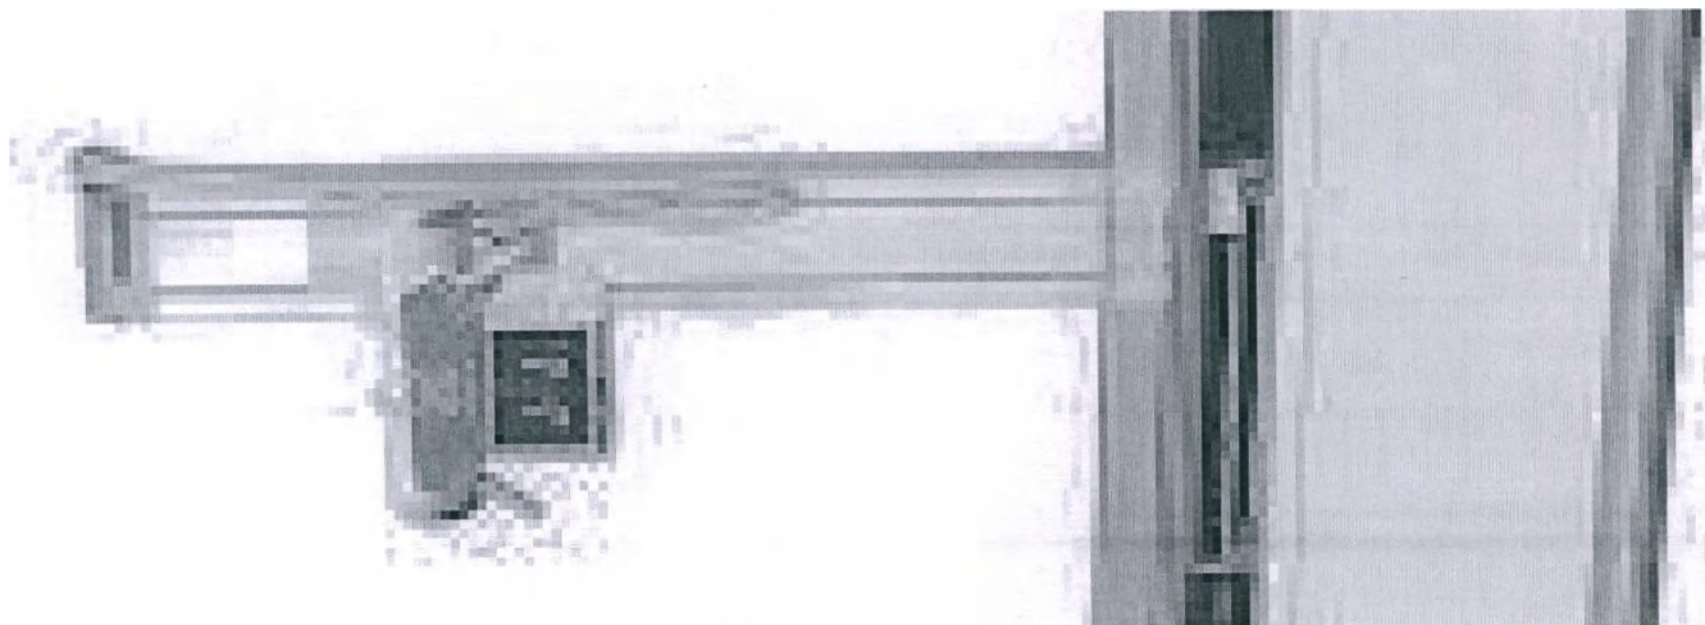

или 3D V производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

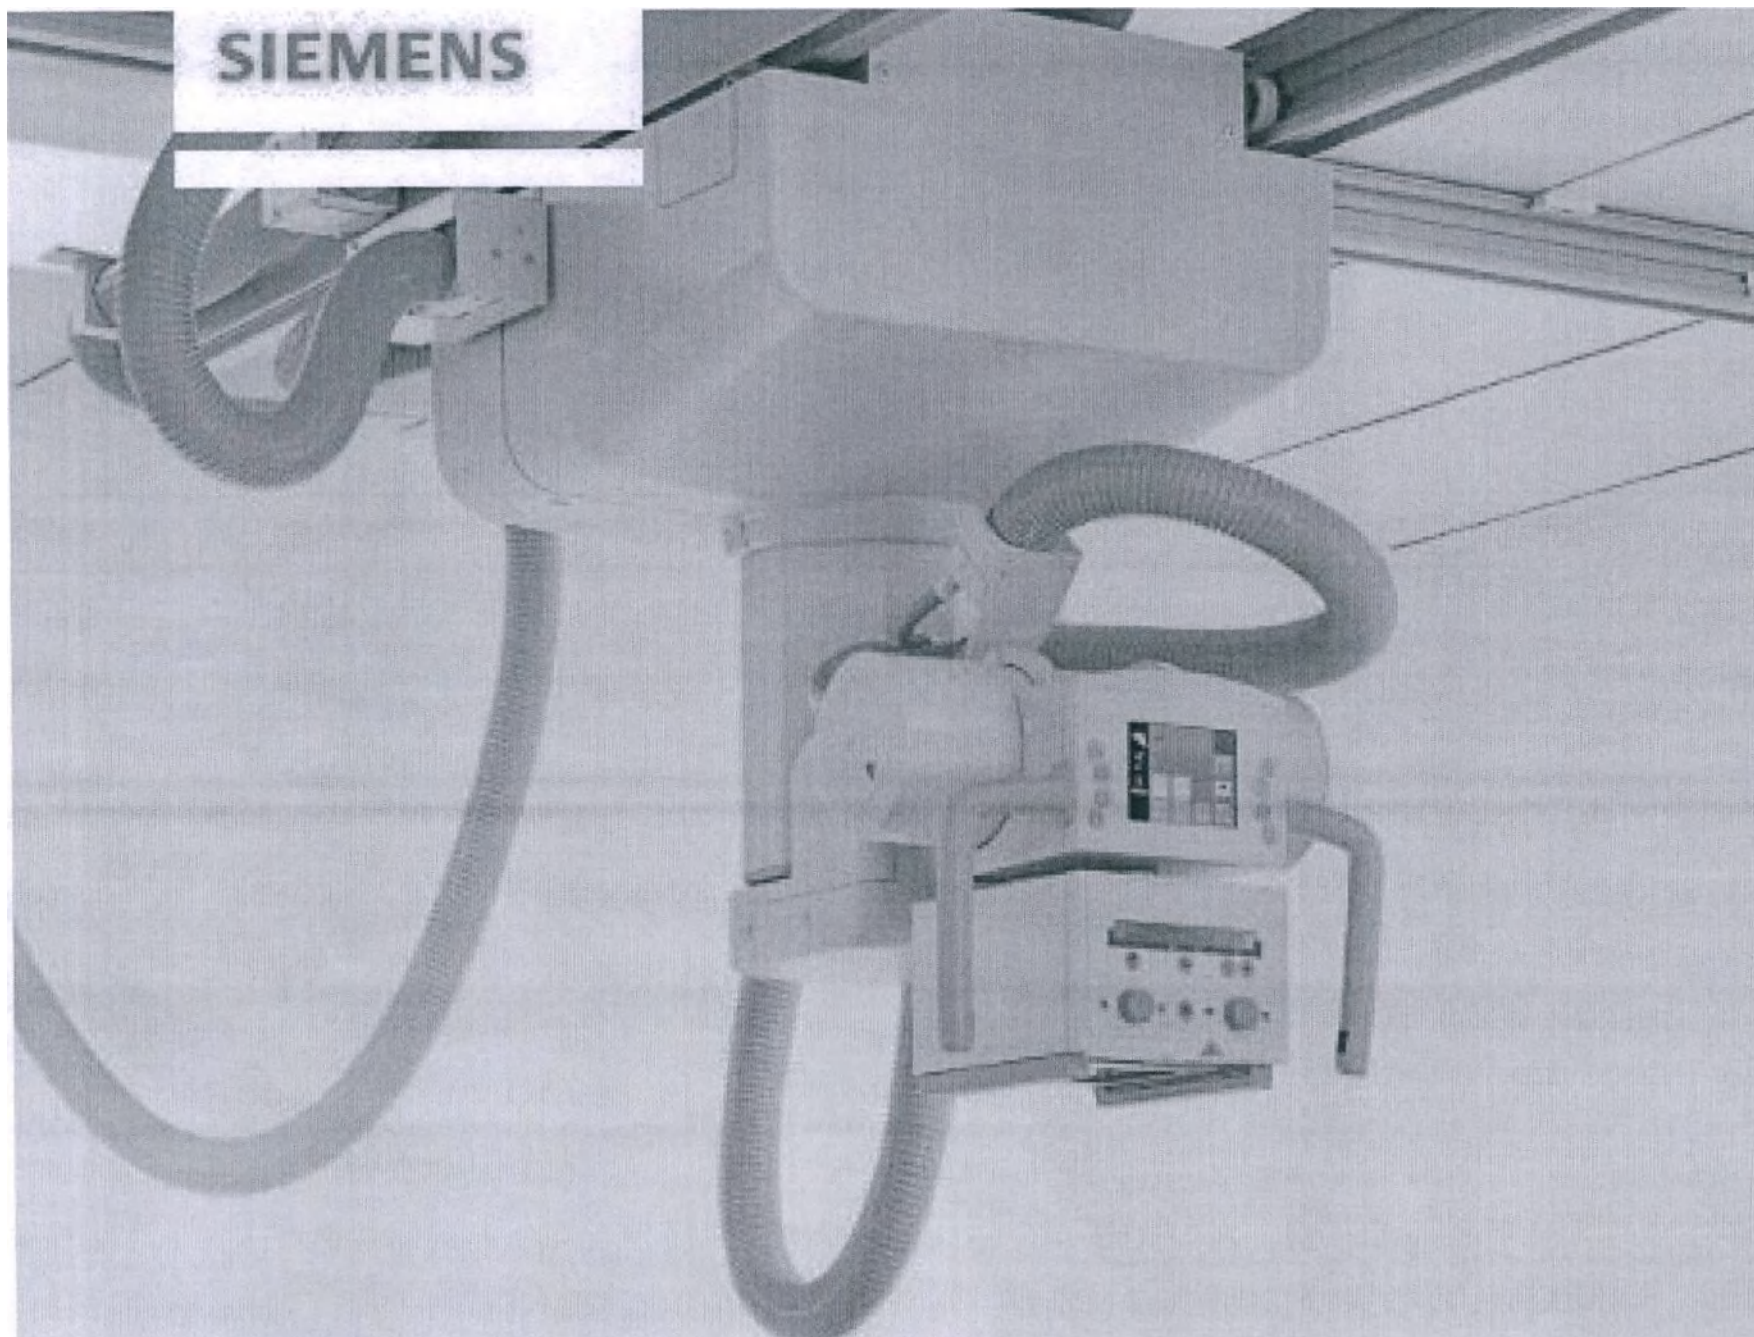


5. Коллиматор (рентгеновская диафрагма) R, производства Ralco S.r.l, Италия;

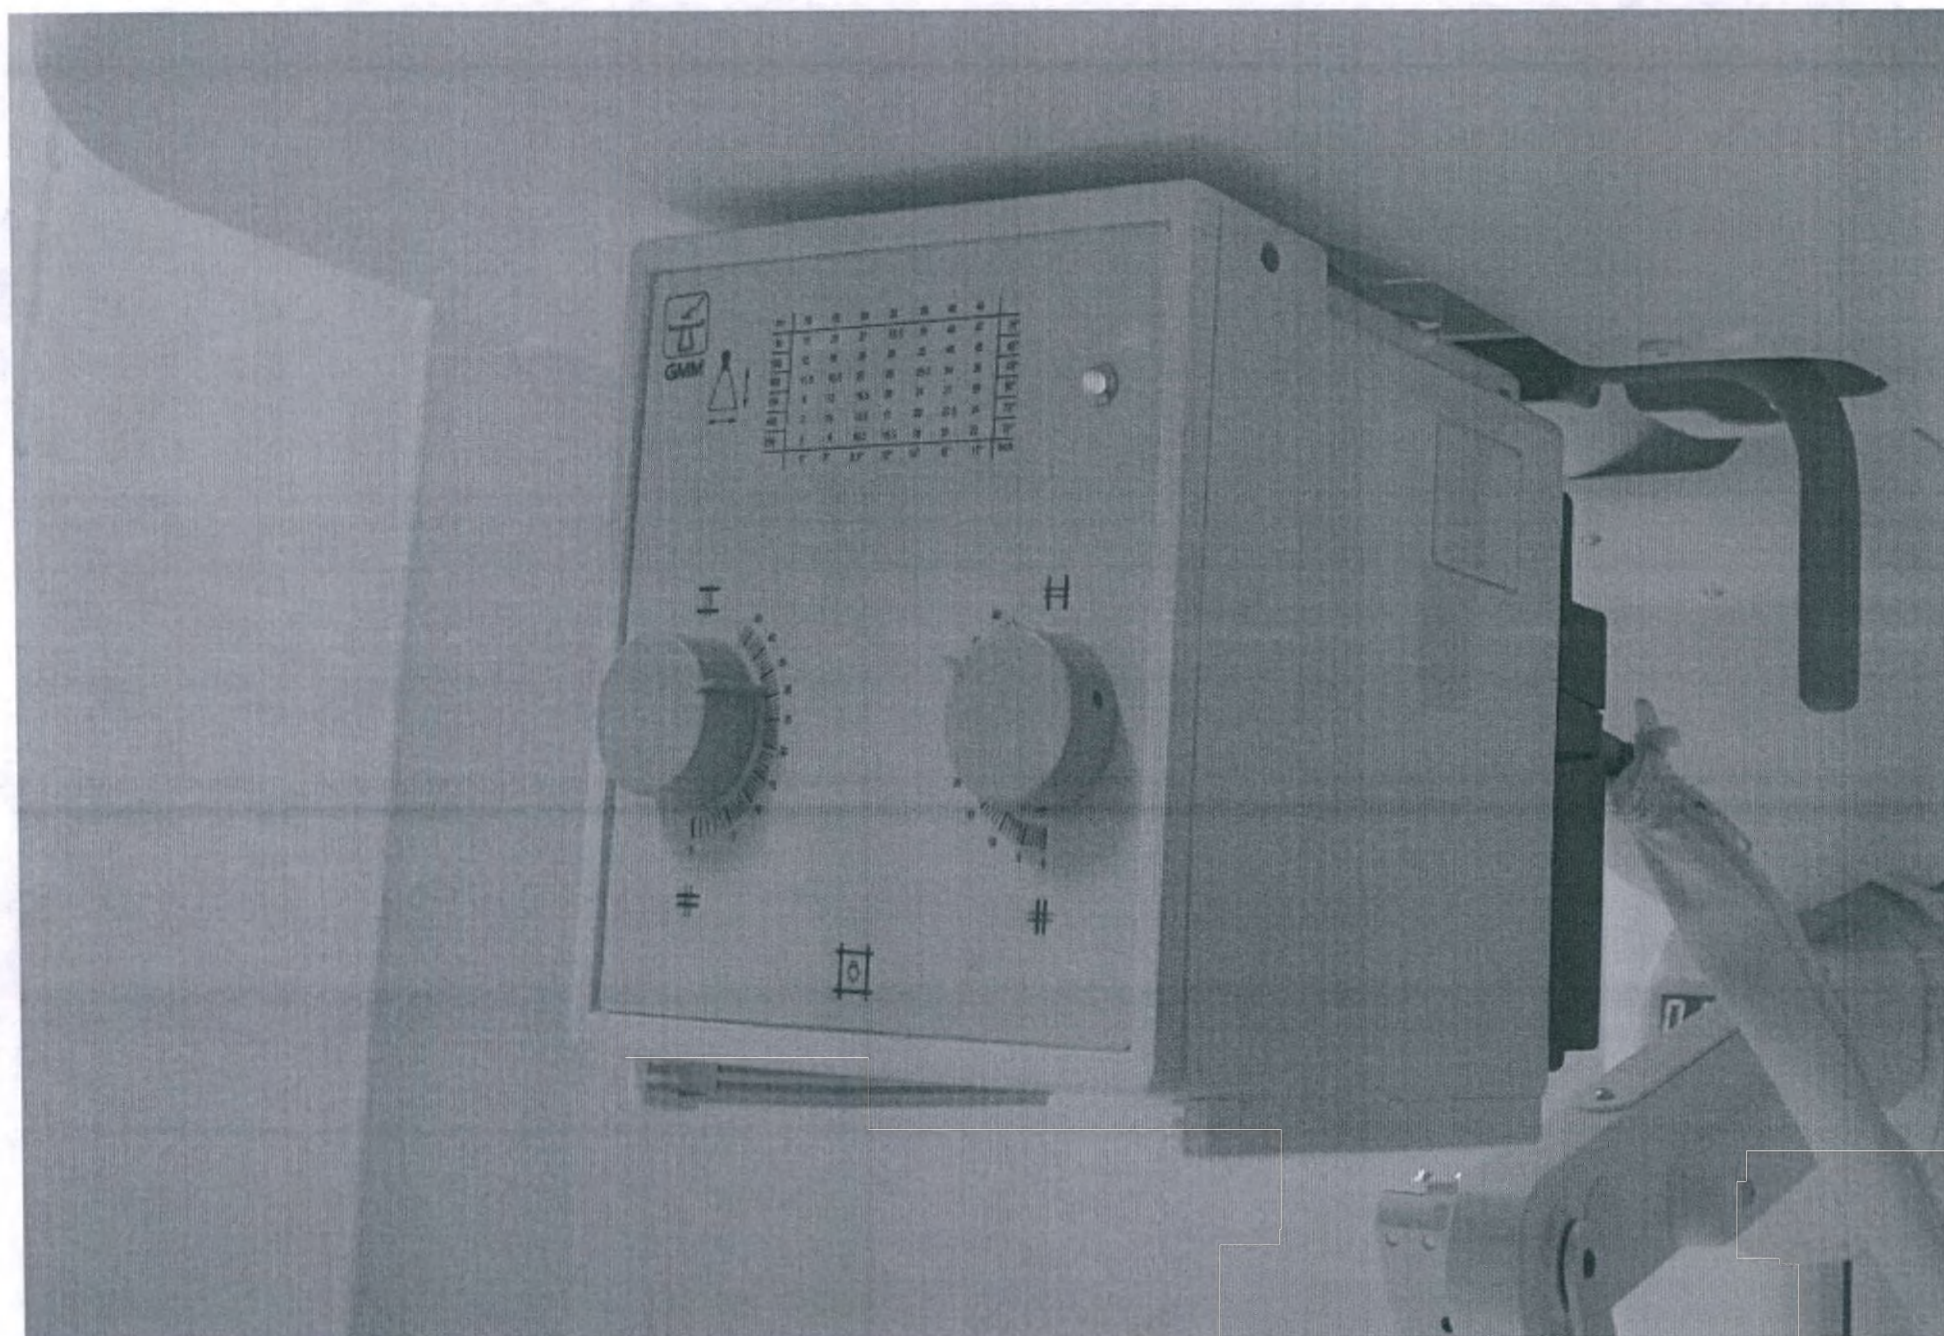


или СМ производства Huestis Medical, США;




или ML; AL; A; AF; AFL производства Siemens Healthcare GmbH, Германия;

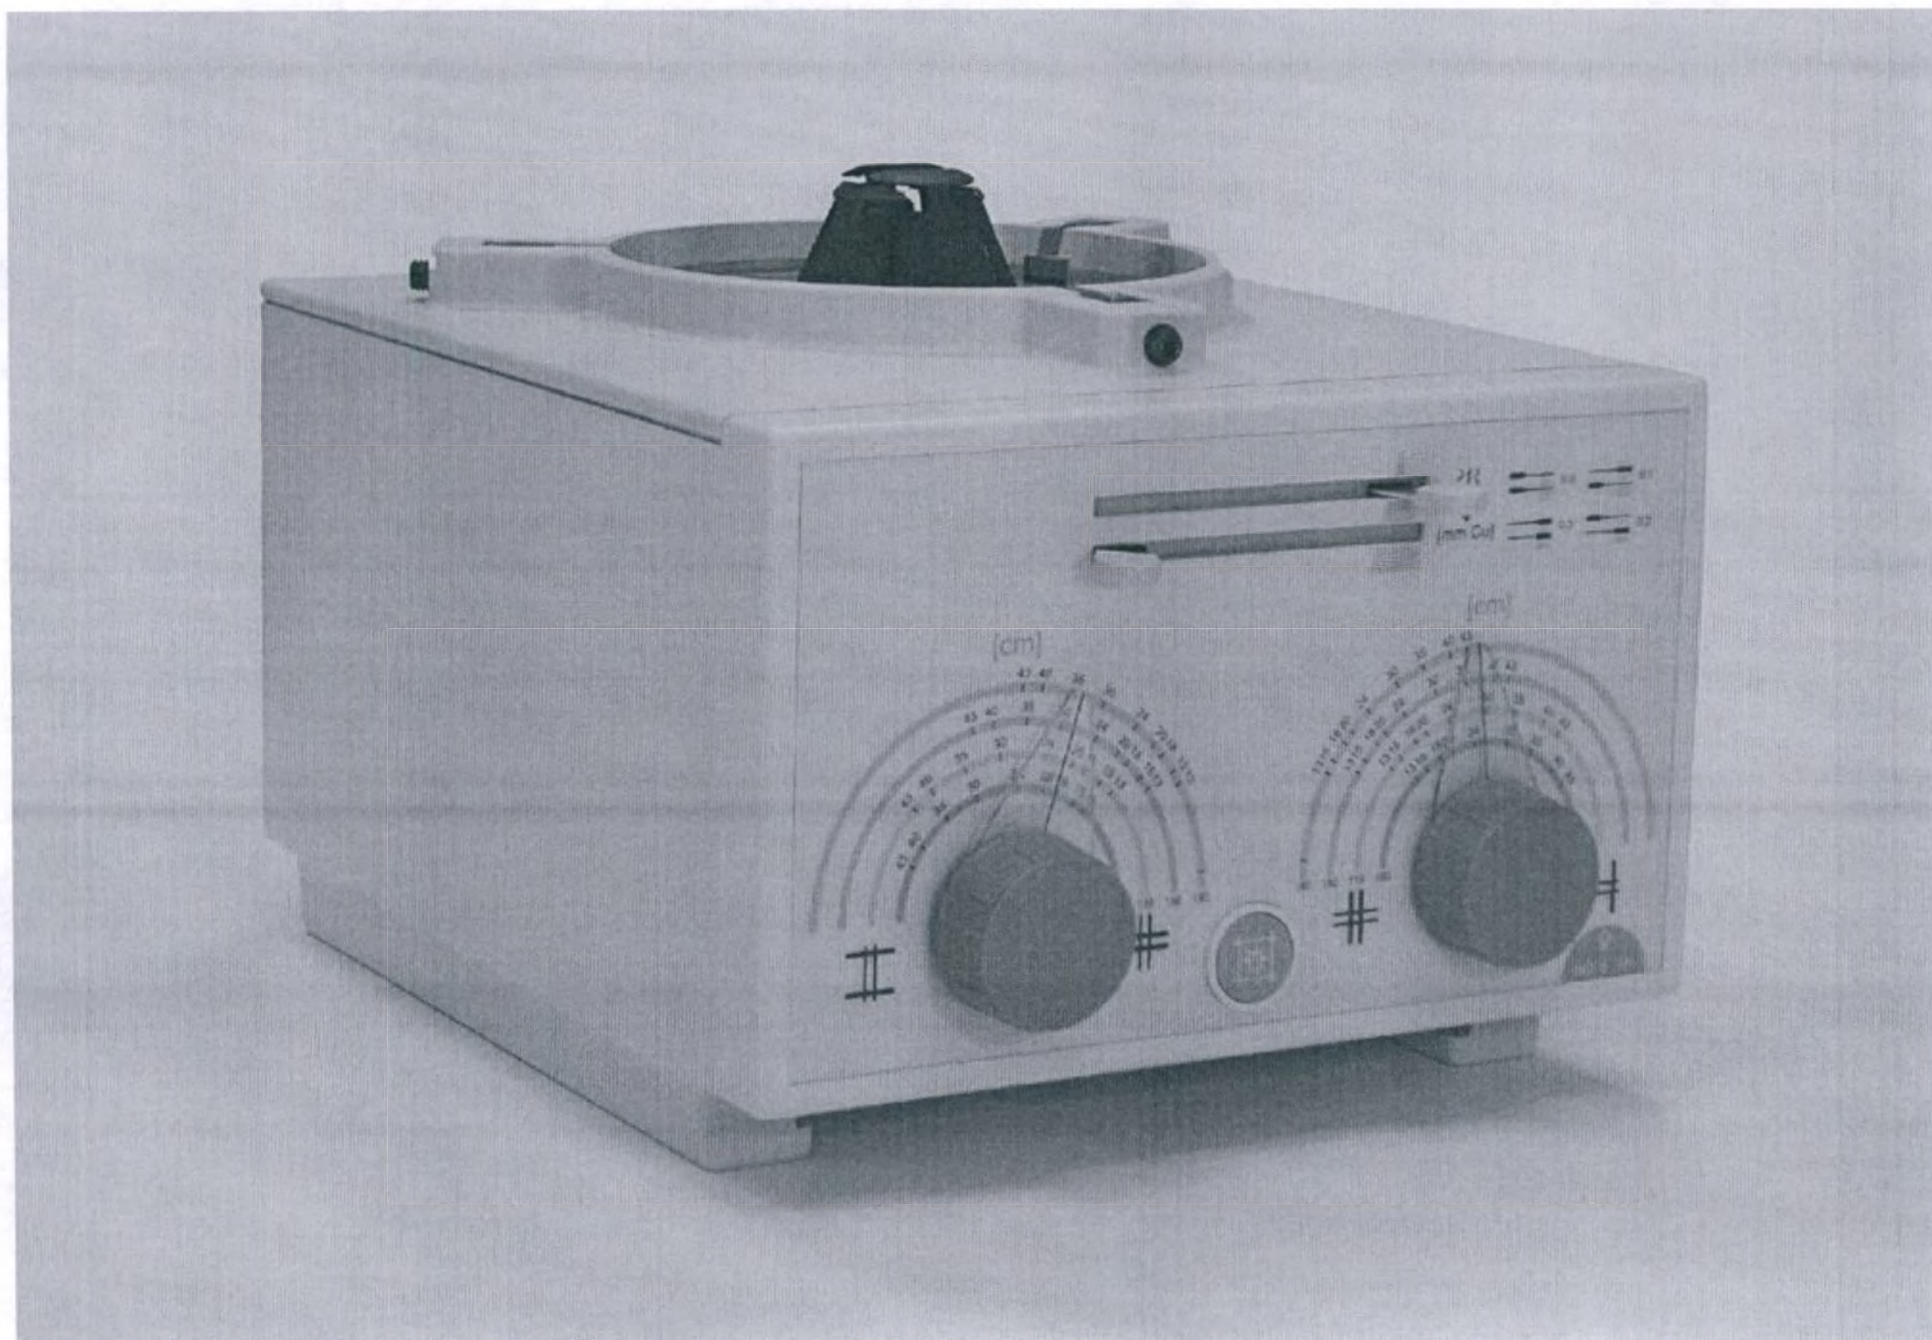


или Optica производства Varex Imaging Corporation, США.

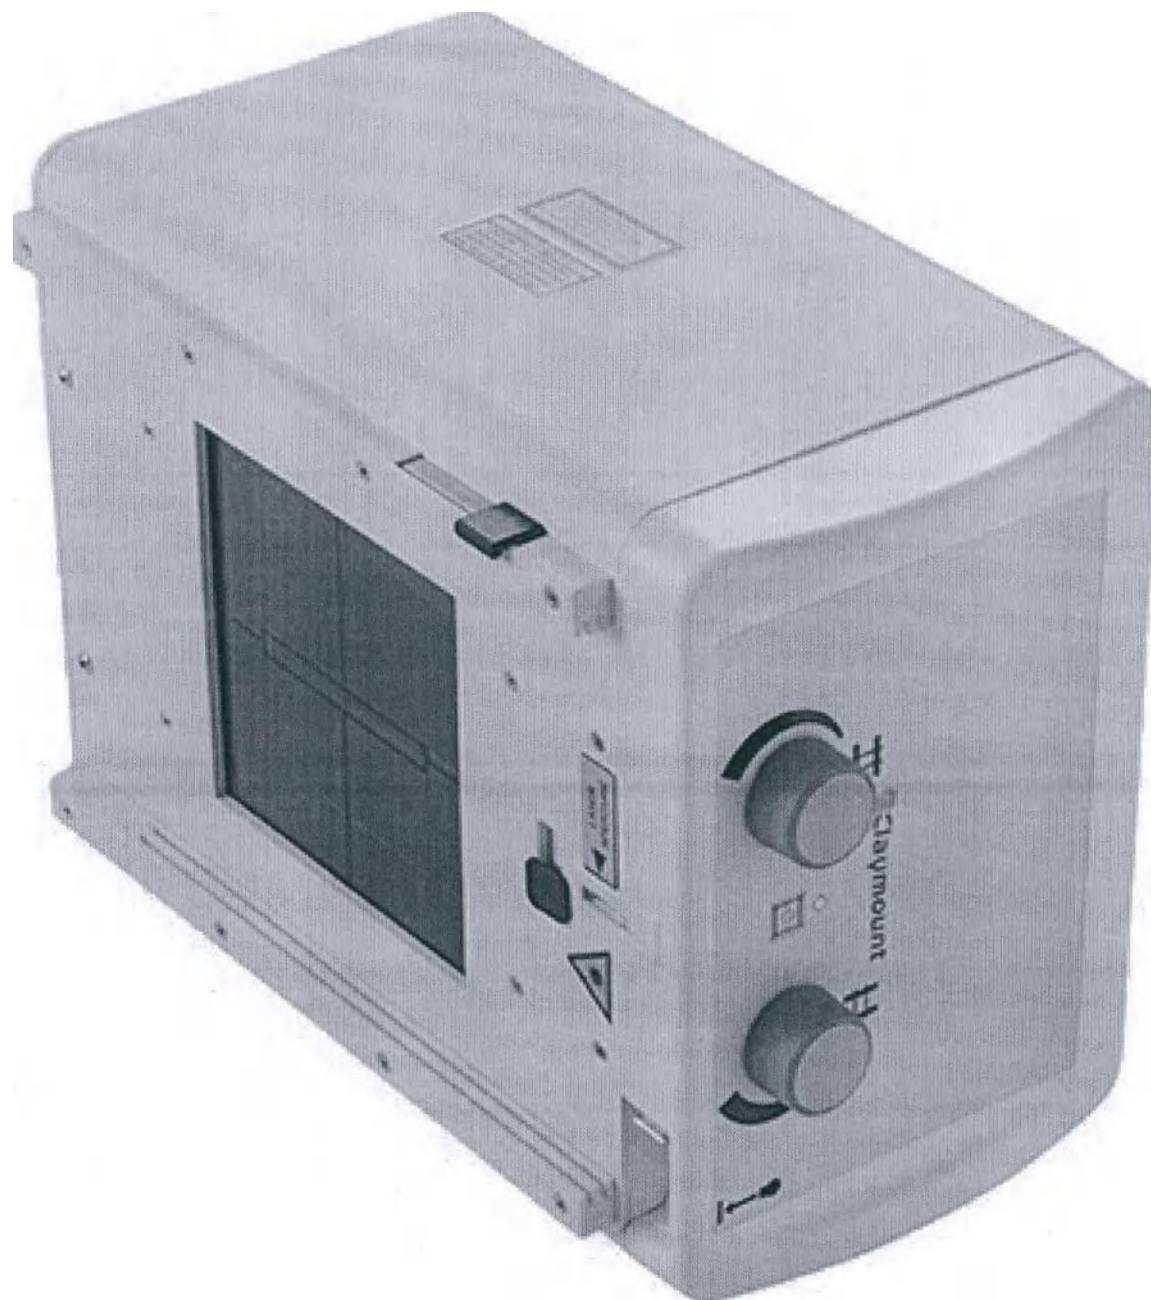


6. Устройство питающее рентгеновское, высокочастотное SHF, HF; SHFR производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания (РУ № ФСЗ 2009/04840);

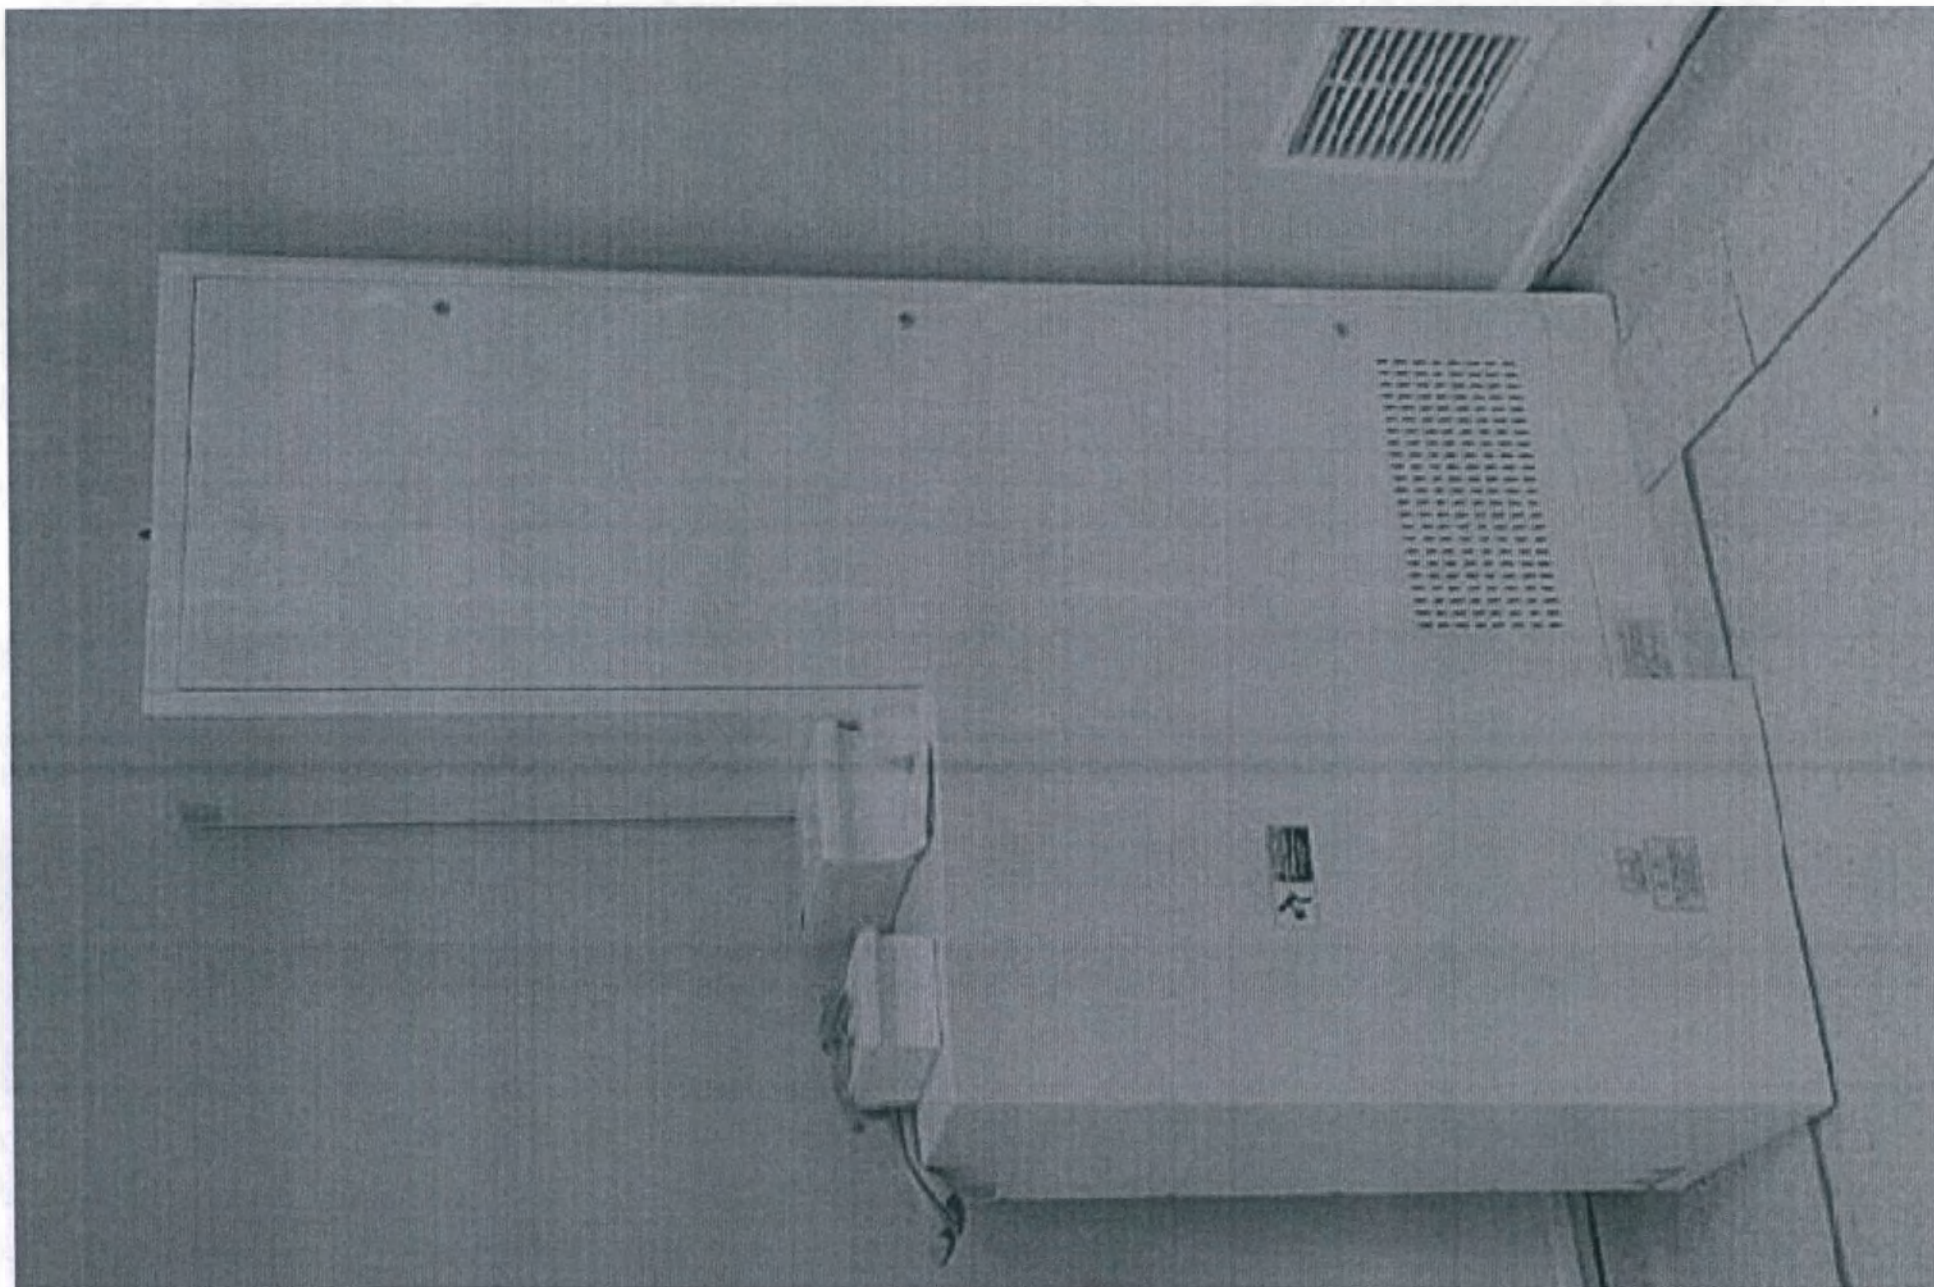

или EPS, EPS EVO производства EMD Technologies LLC, Канада;

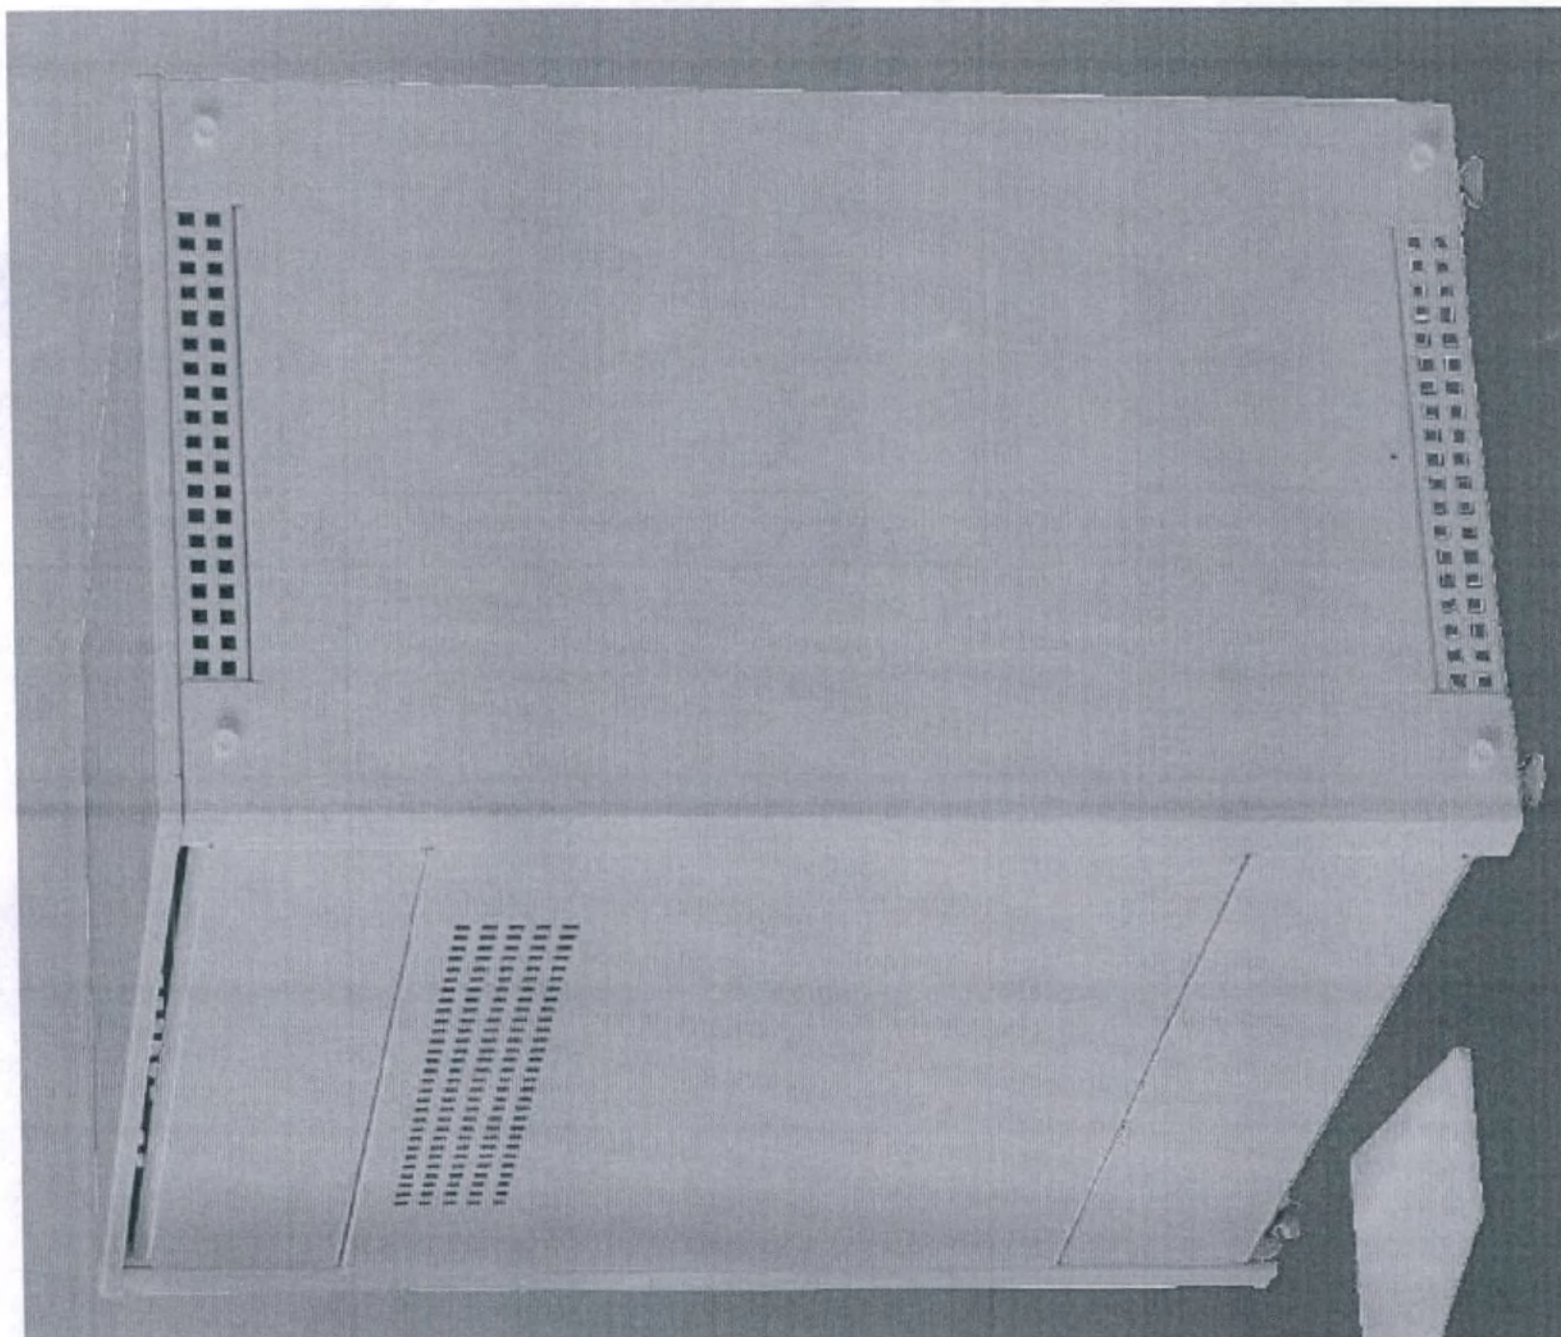


или Indico, СМР производства Communications & Power Industries Canada, Inc., Канада;

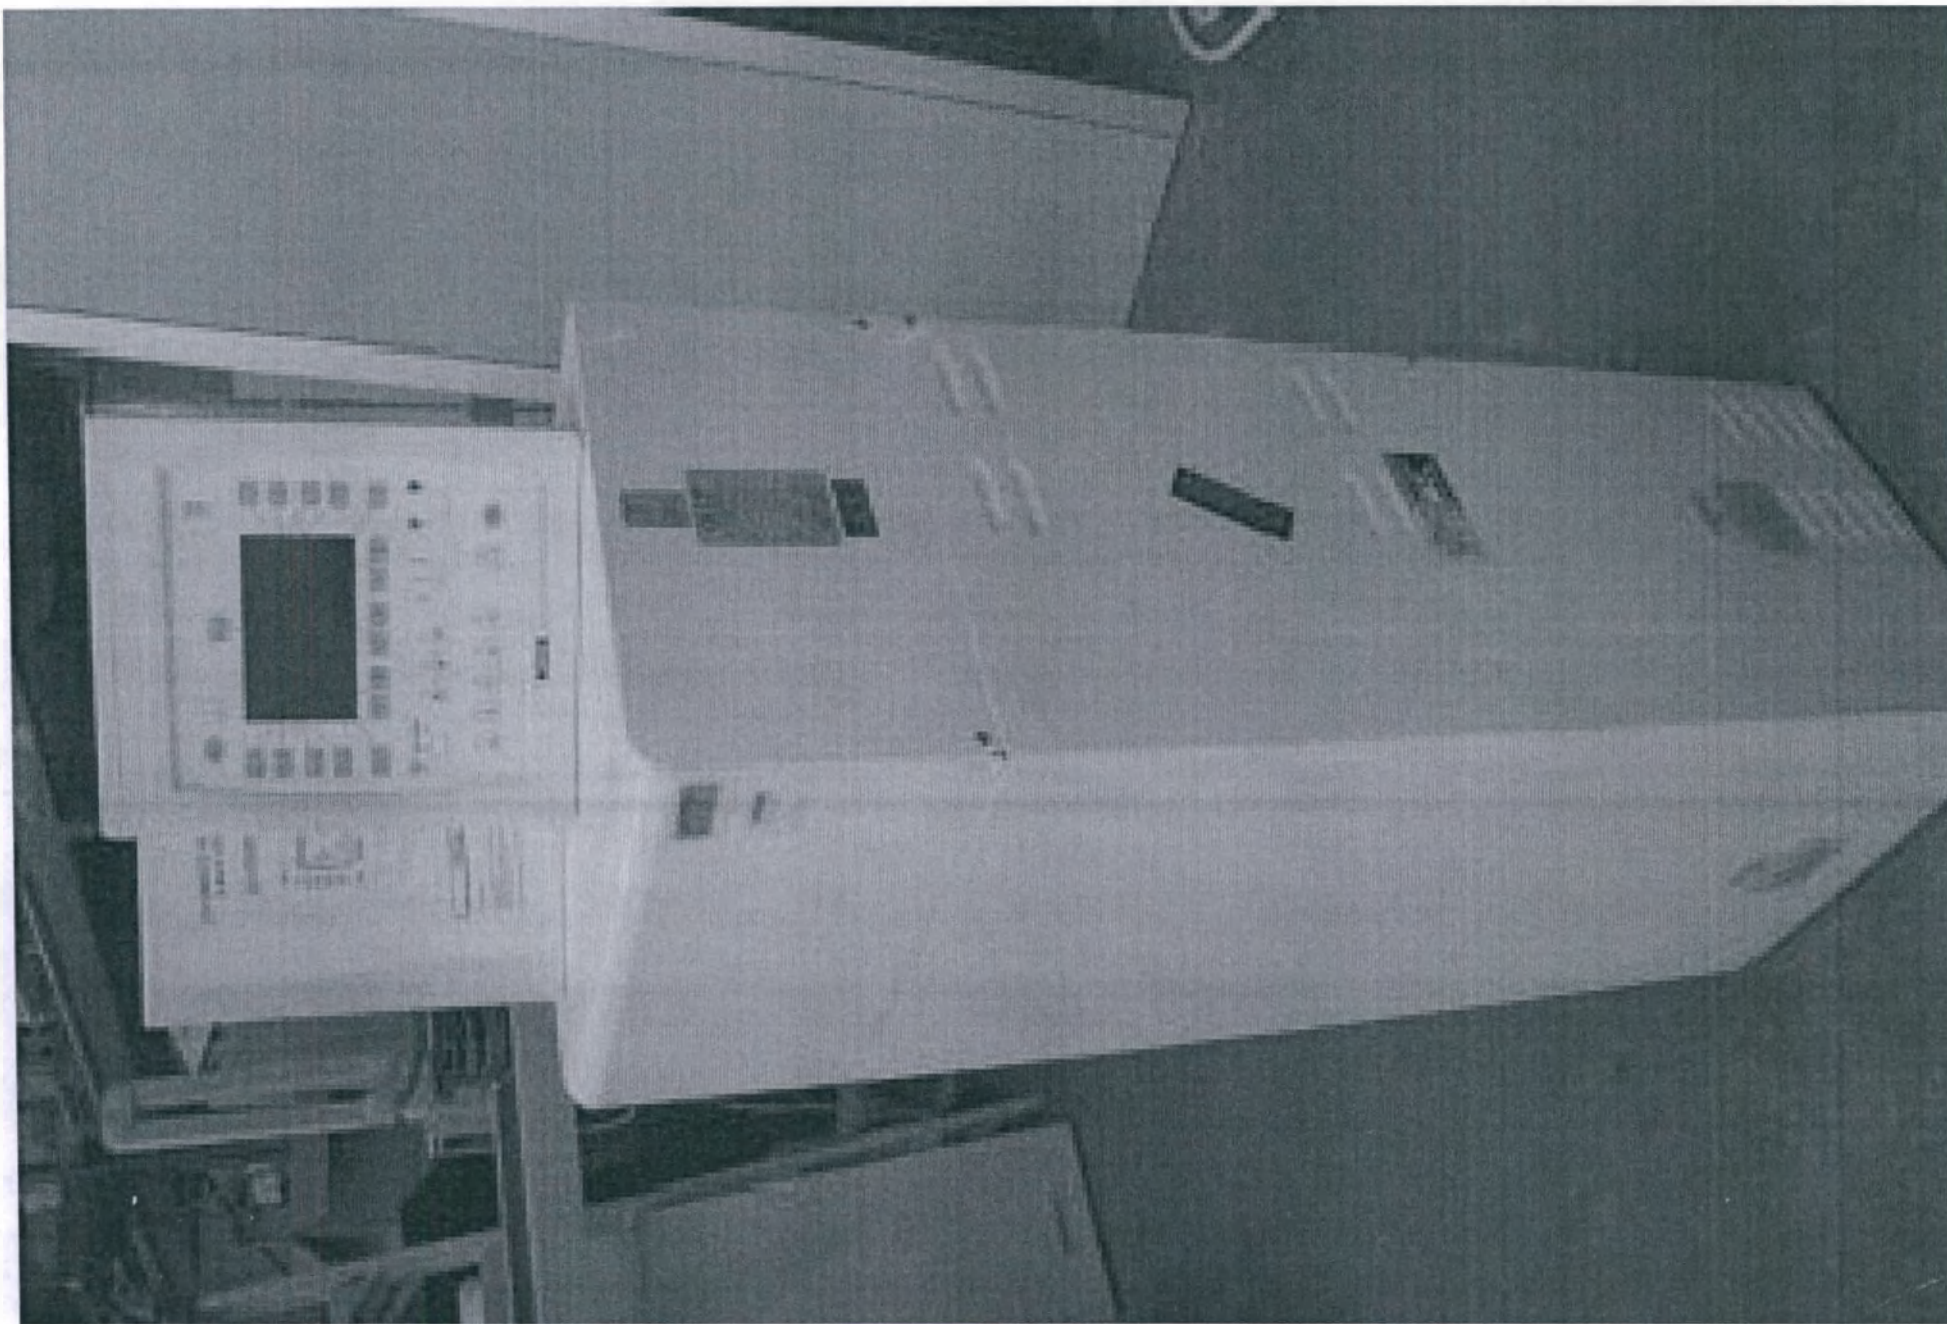


или Z, HFE производства Spellman High Voltage Electronics Corporation, США;




или Polydoros RF; Polydoros RF Rad производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

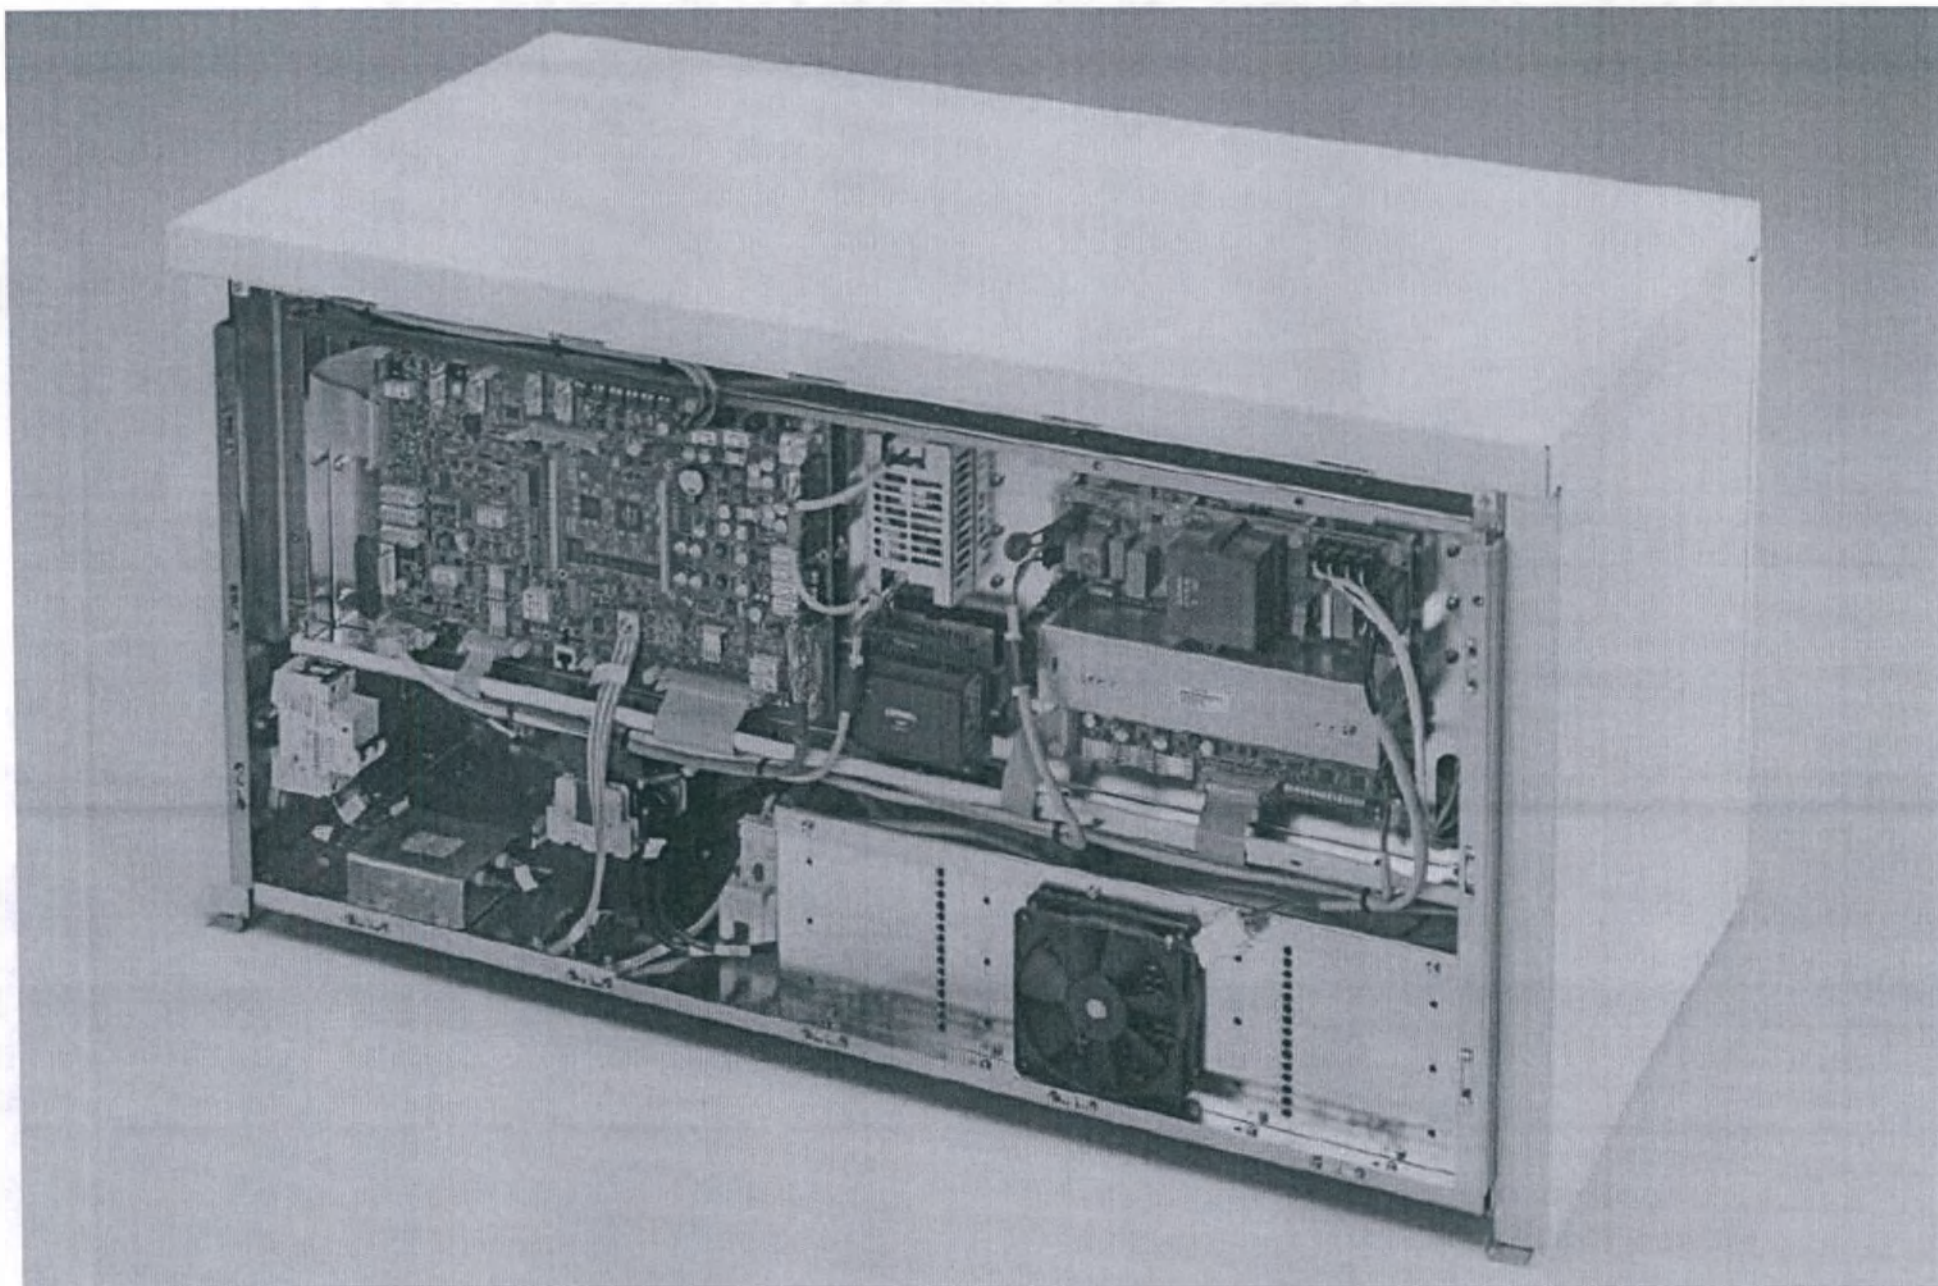


7. Стол поворотный IMX производства Imago Radiology S.r.l., Италия;

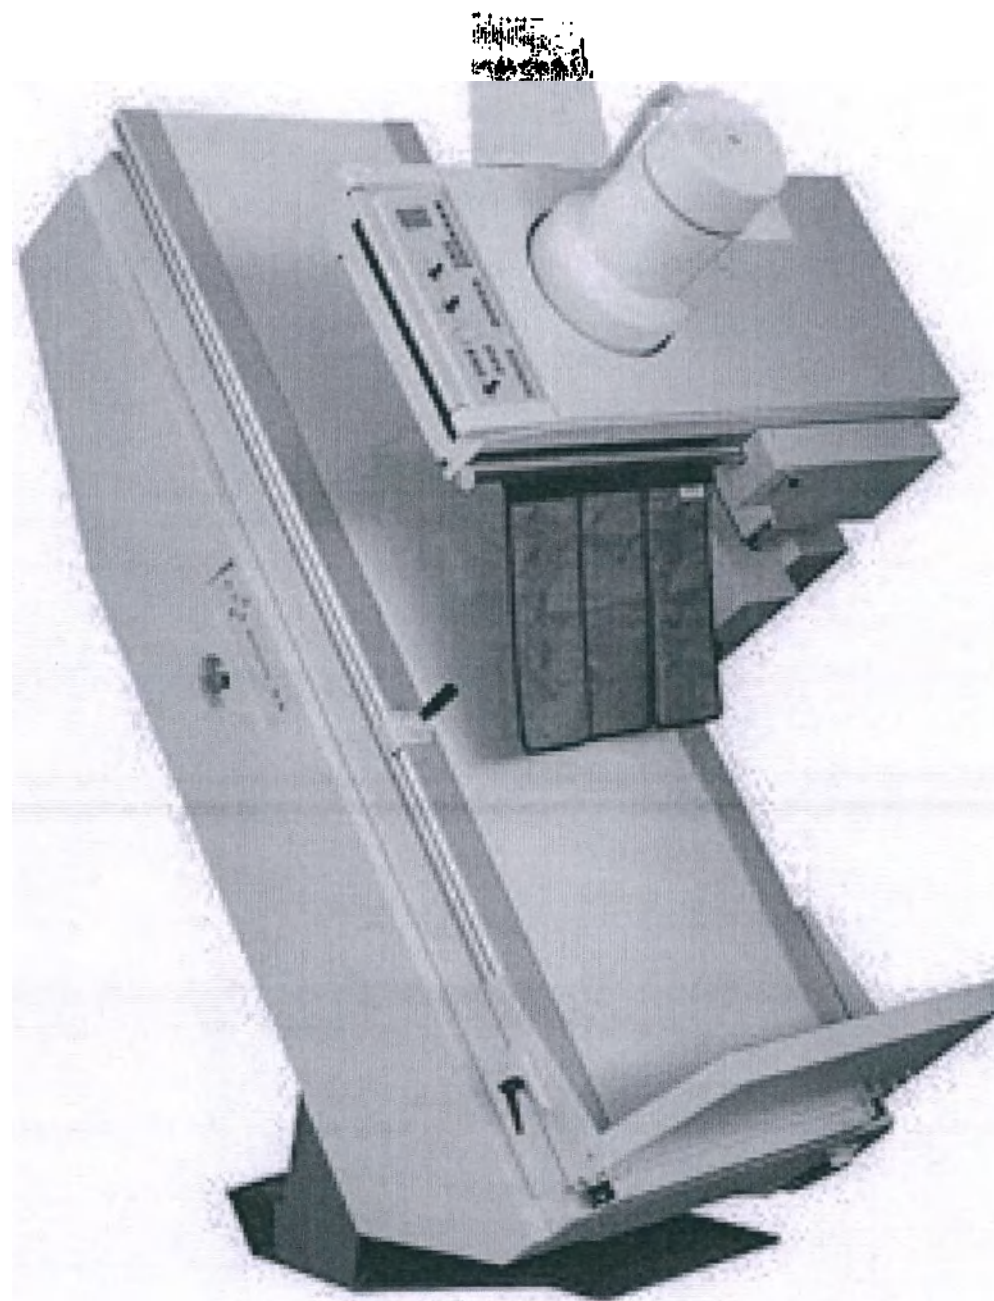


или Орега производства General Medical Merate SPA (GMM), Италия;

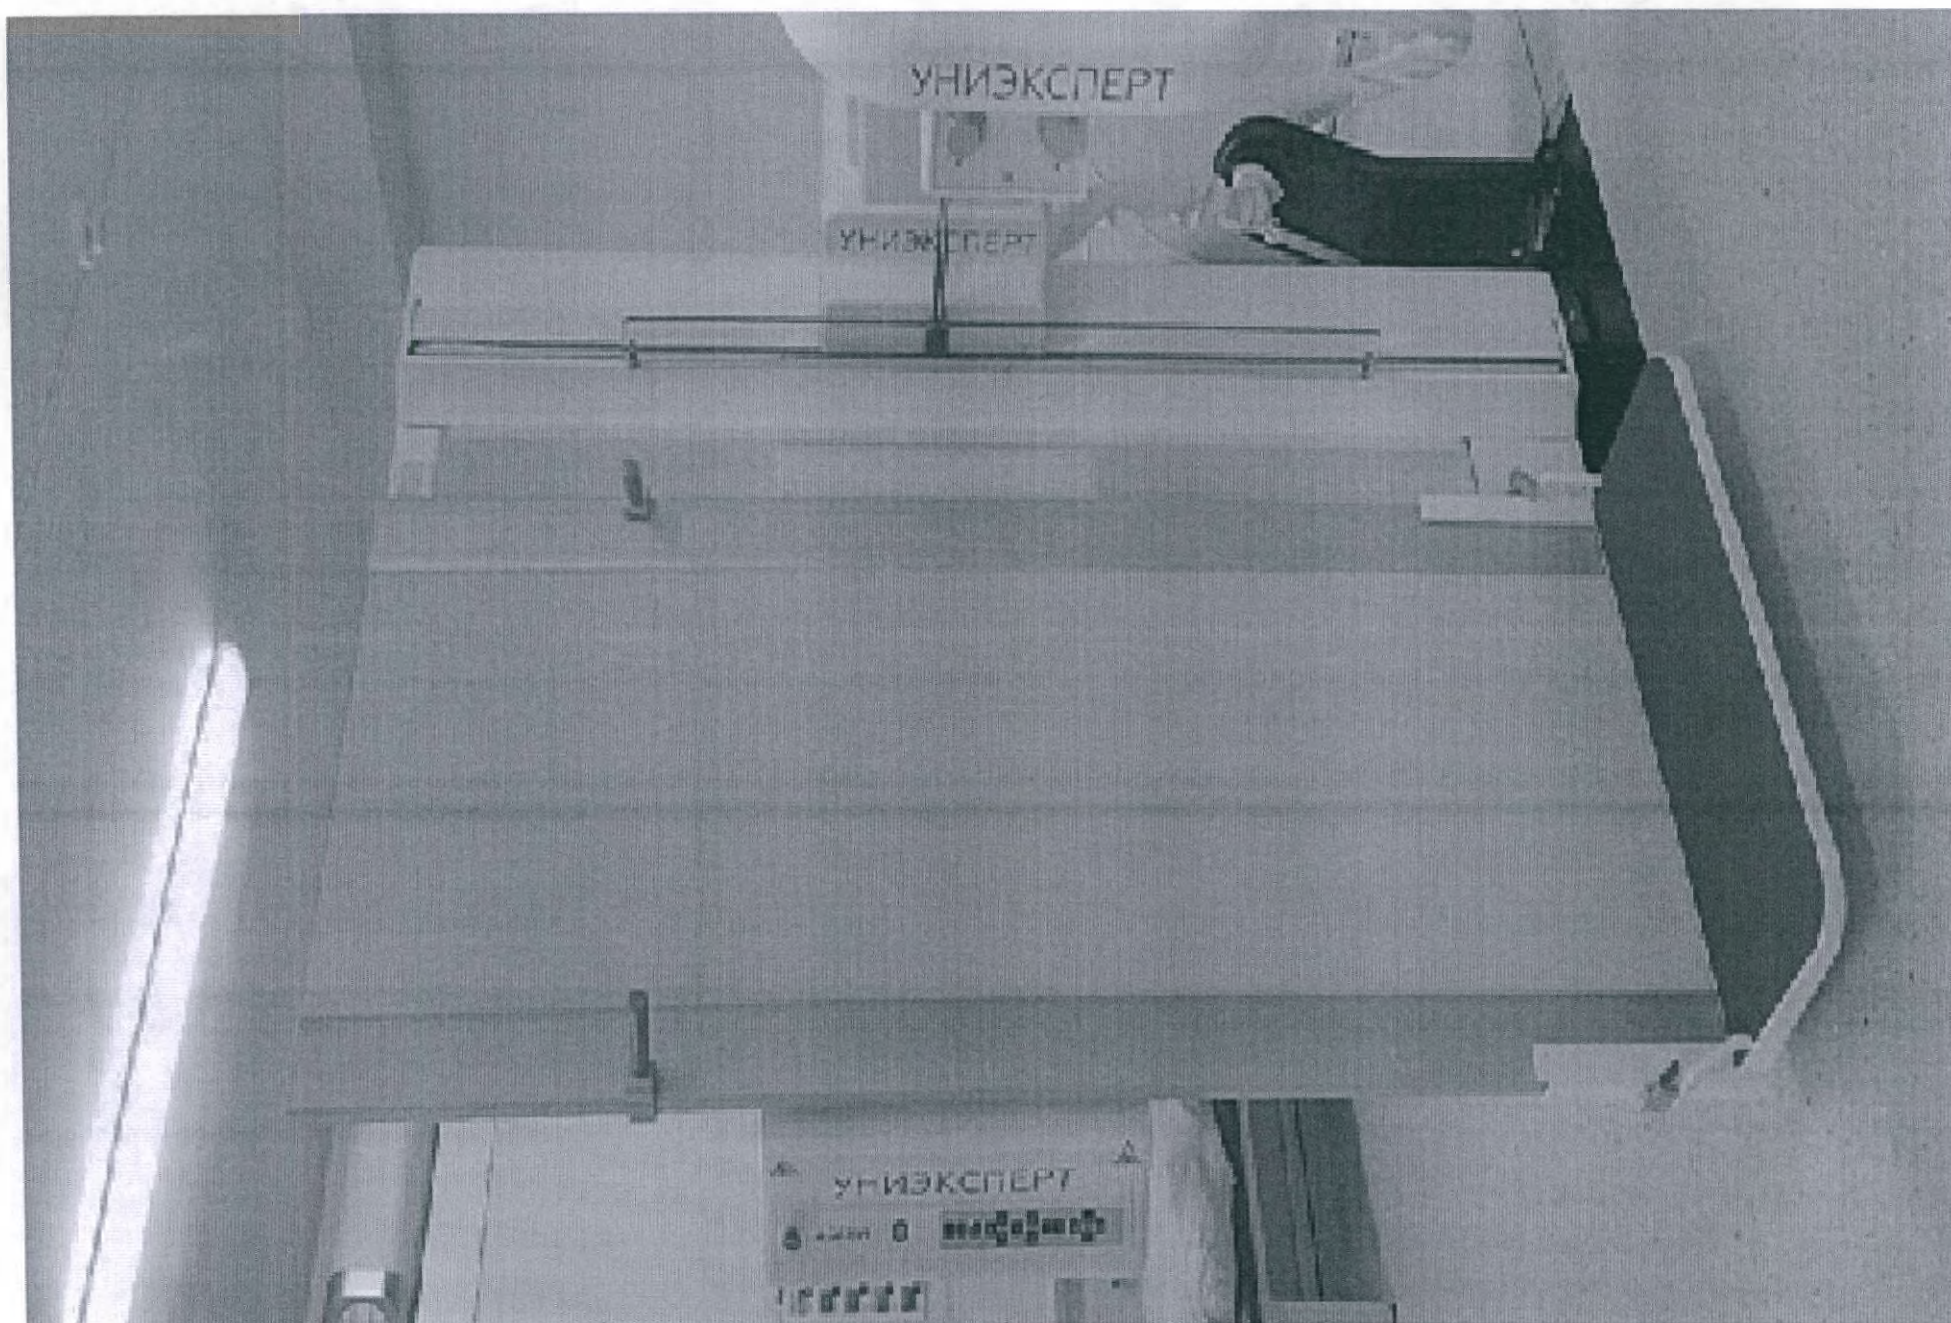


или Vision производства VILLA SISTEMI MEDICALI s.p.a., Италия;

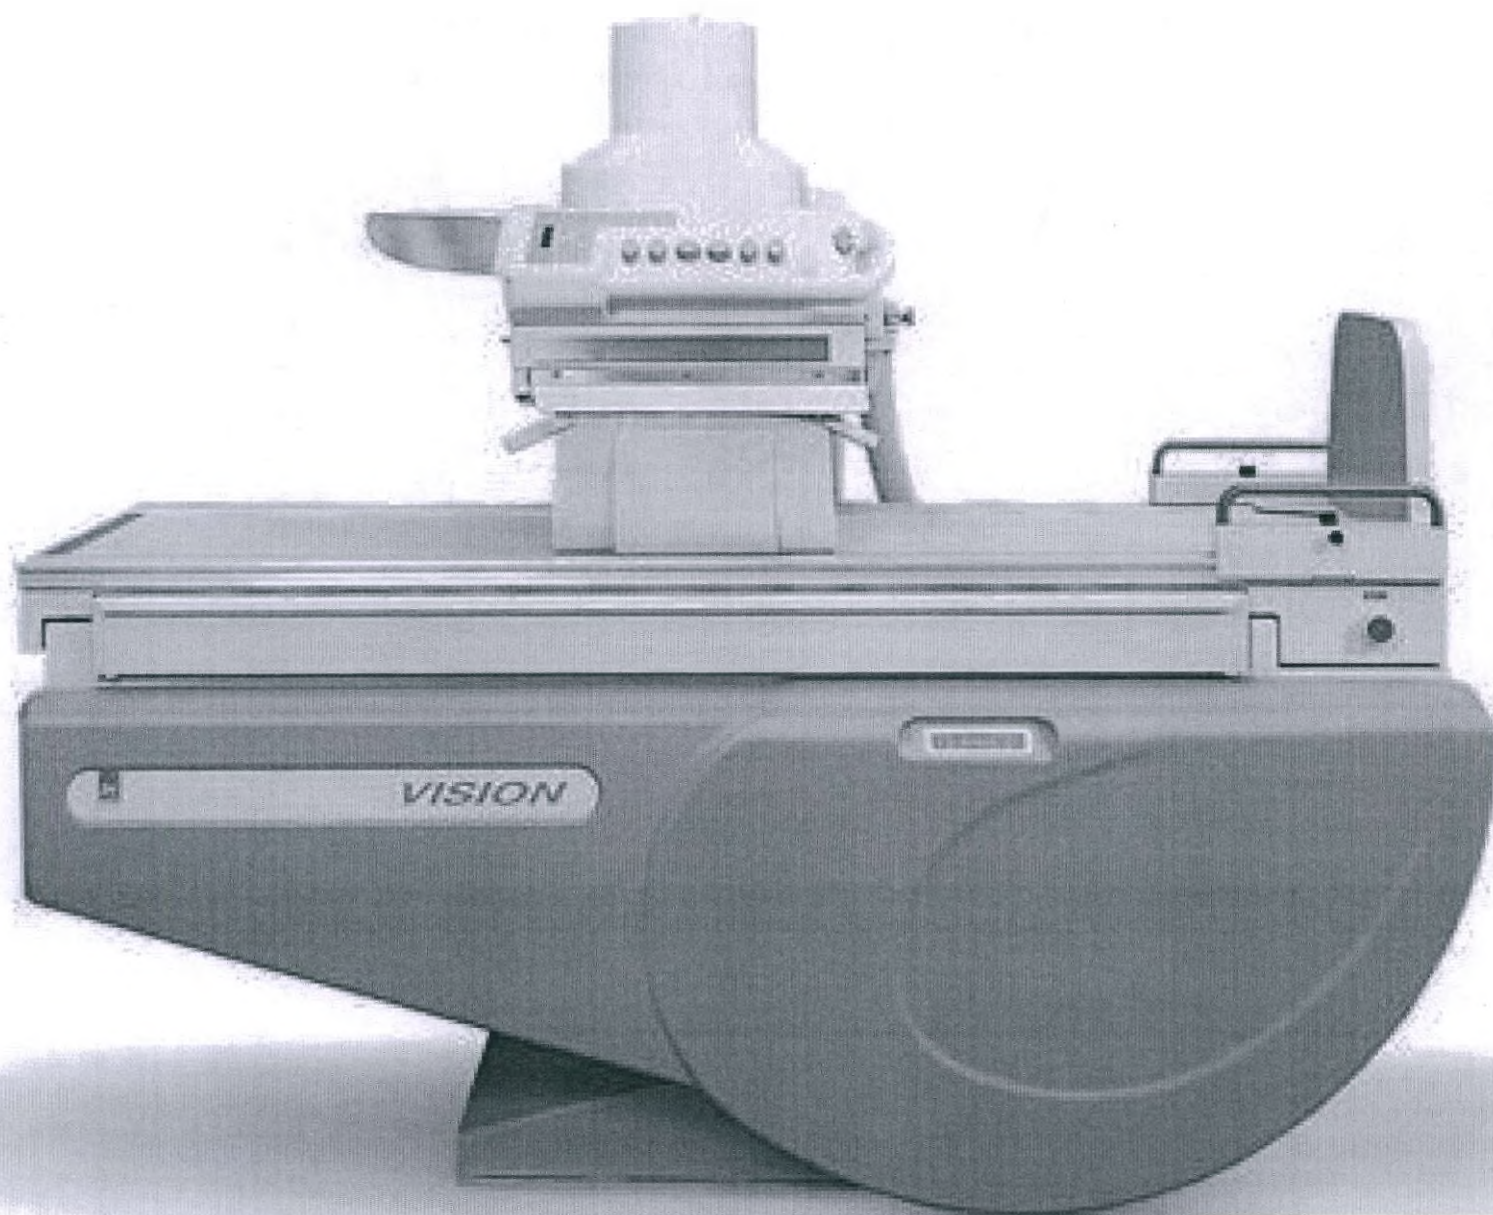


или серии АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

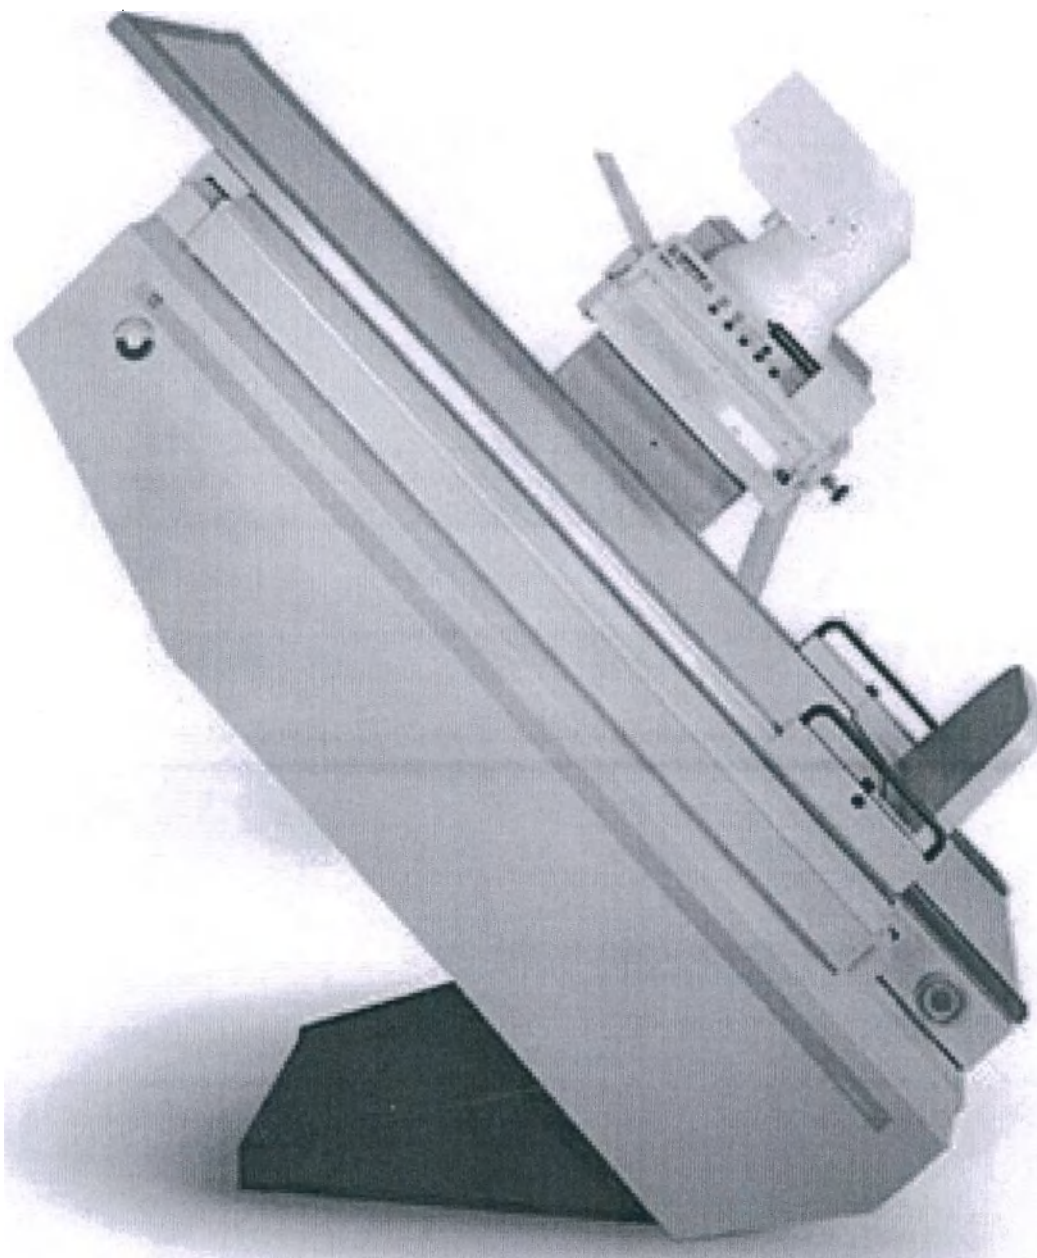


или Millenium производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания; или Optima, Platinum производства Diagnostic Medical System Apelem, Франция.

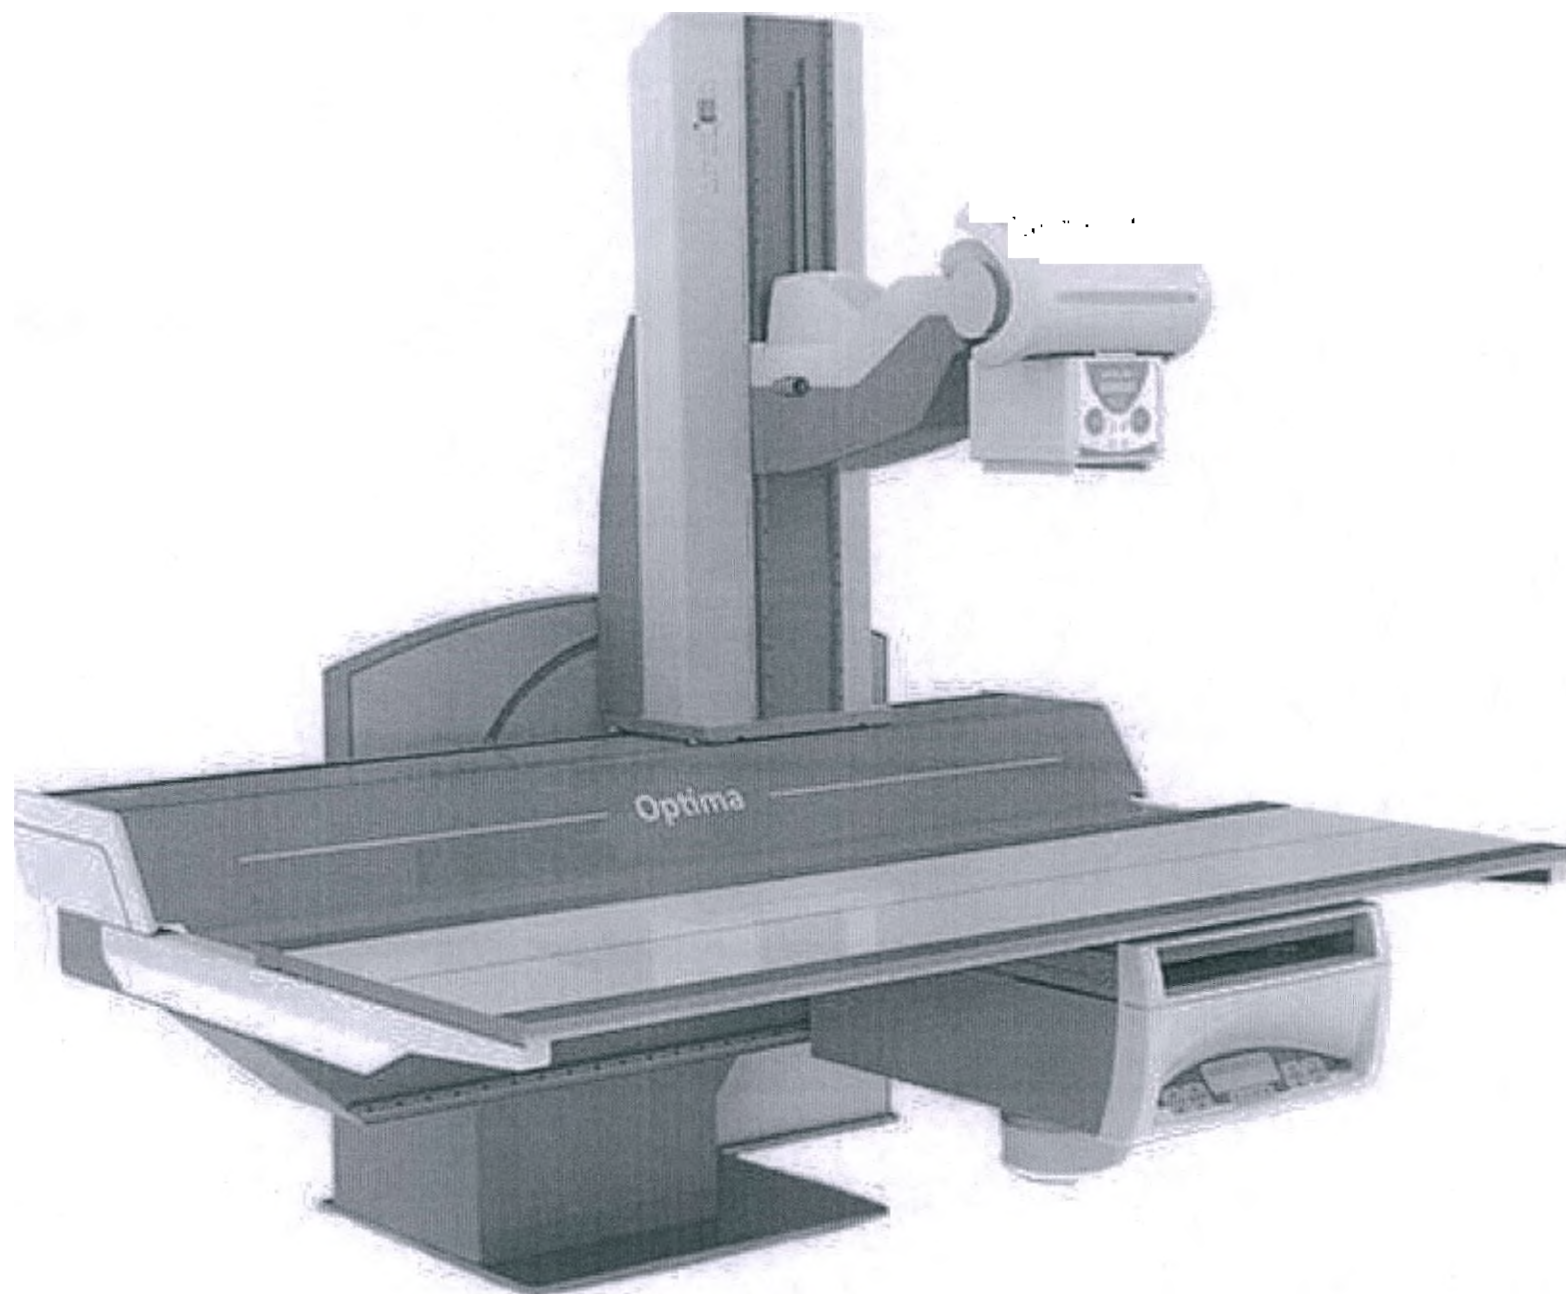


8. Усилитель рентгеновского изображения ТН производства Thales Electron Devices SAS, Франция;

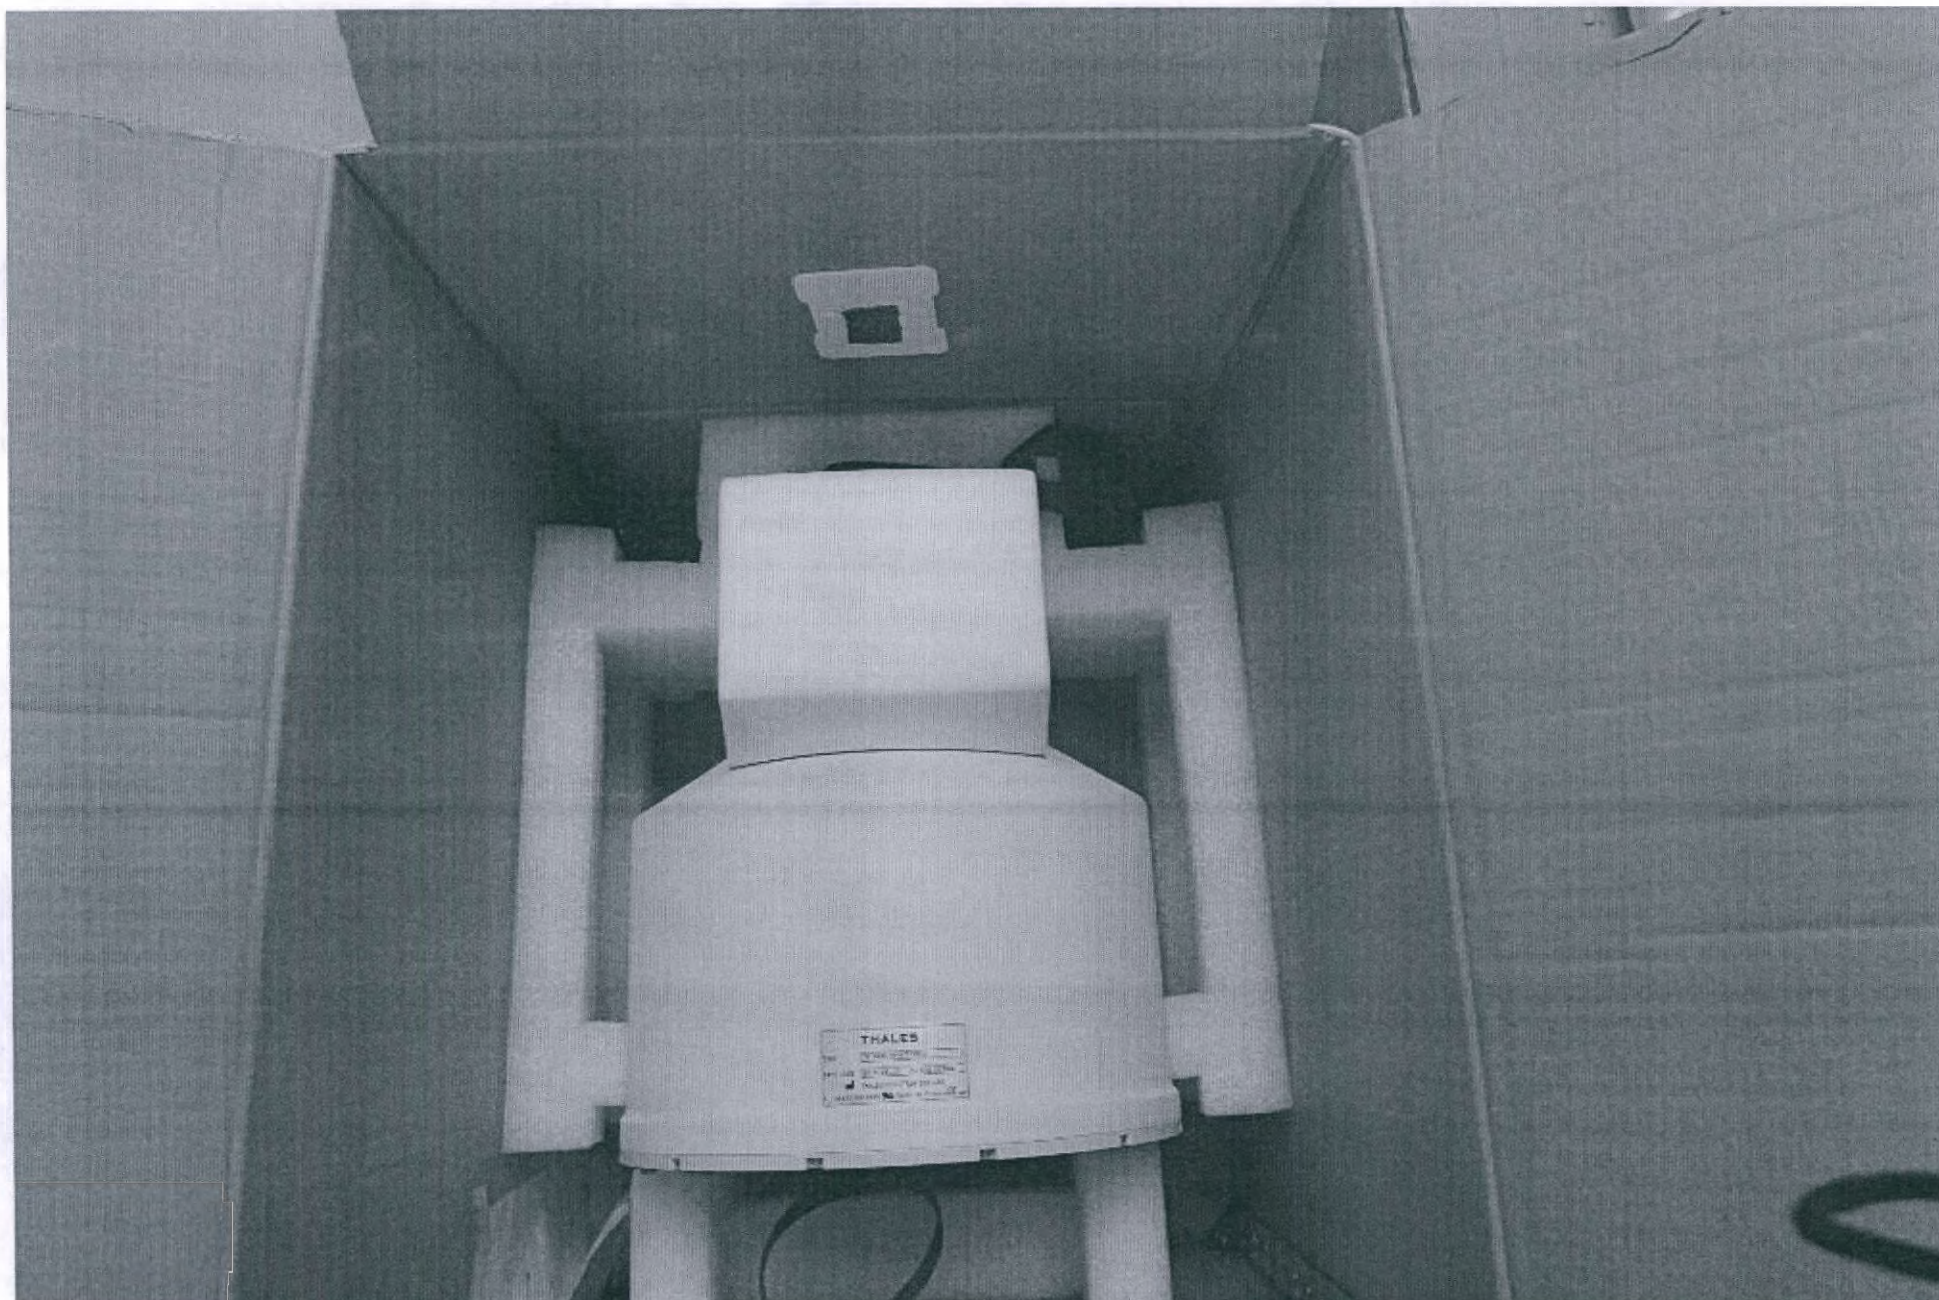


или Е производства Canon Medical System Corporation, Япония;

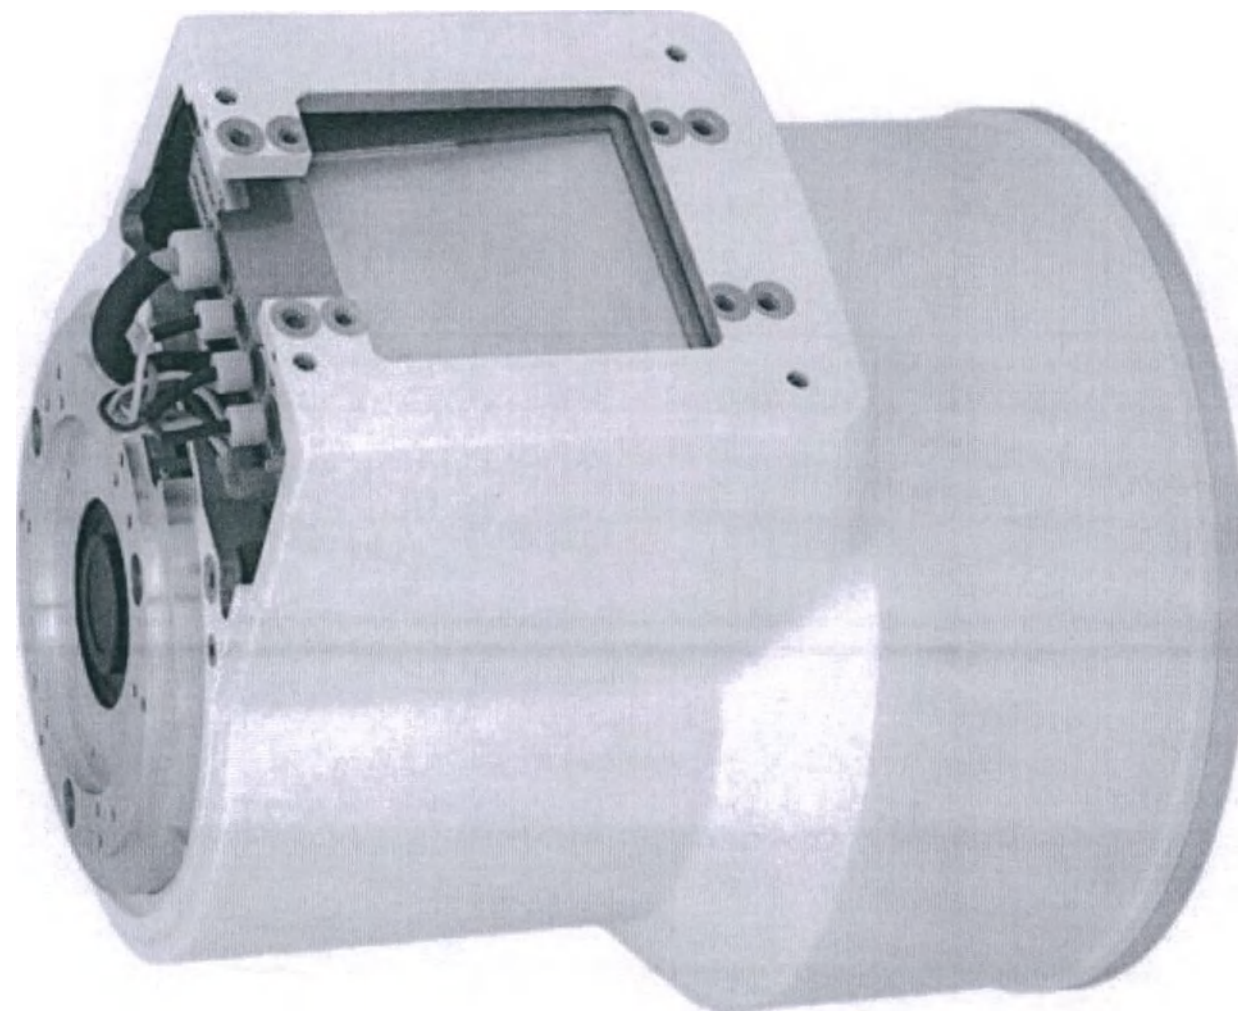


или устройства усиления и формирования рентгеновского изображения HIDEQ производства Siemens Healthcare GmbH, Германия (РУ № ФСЗ 2010/06086).

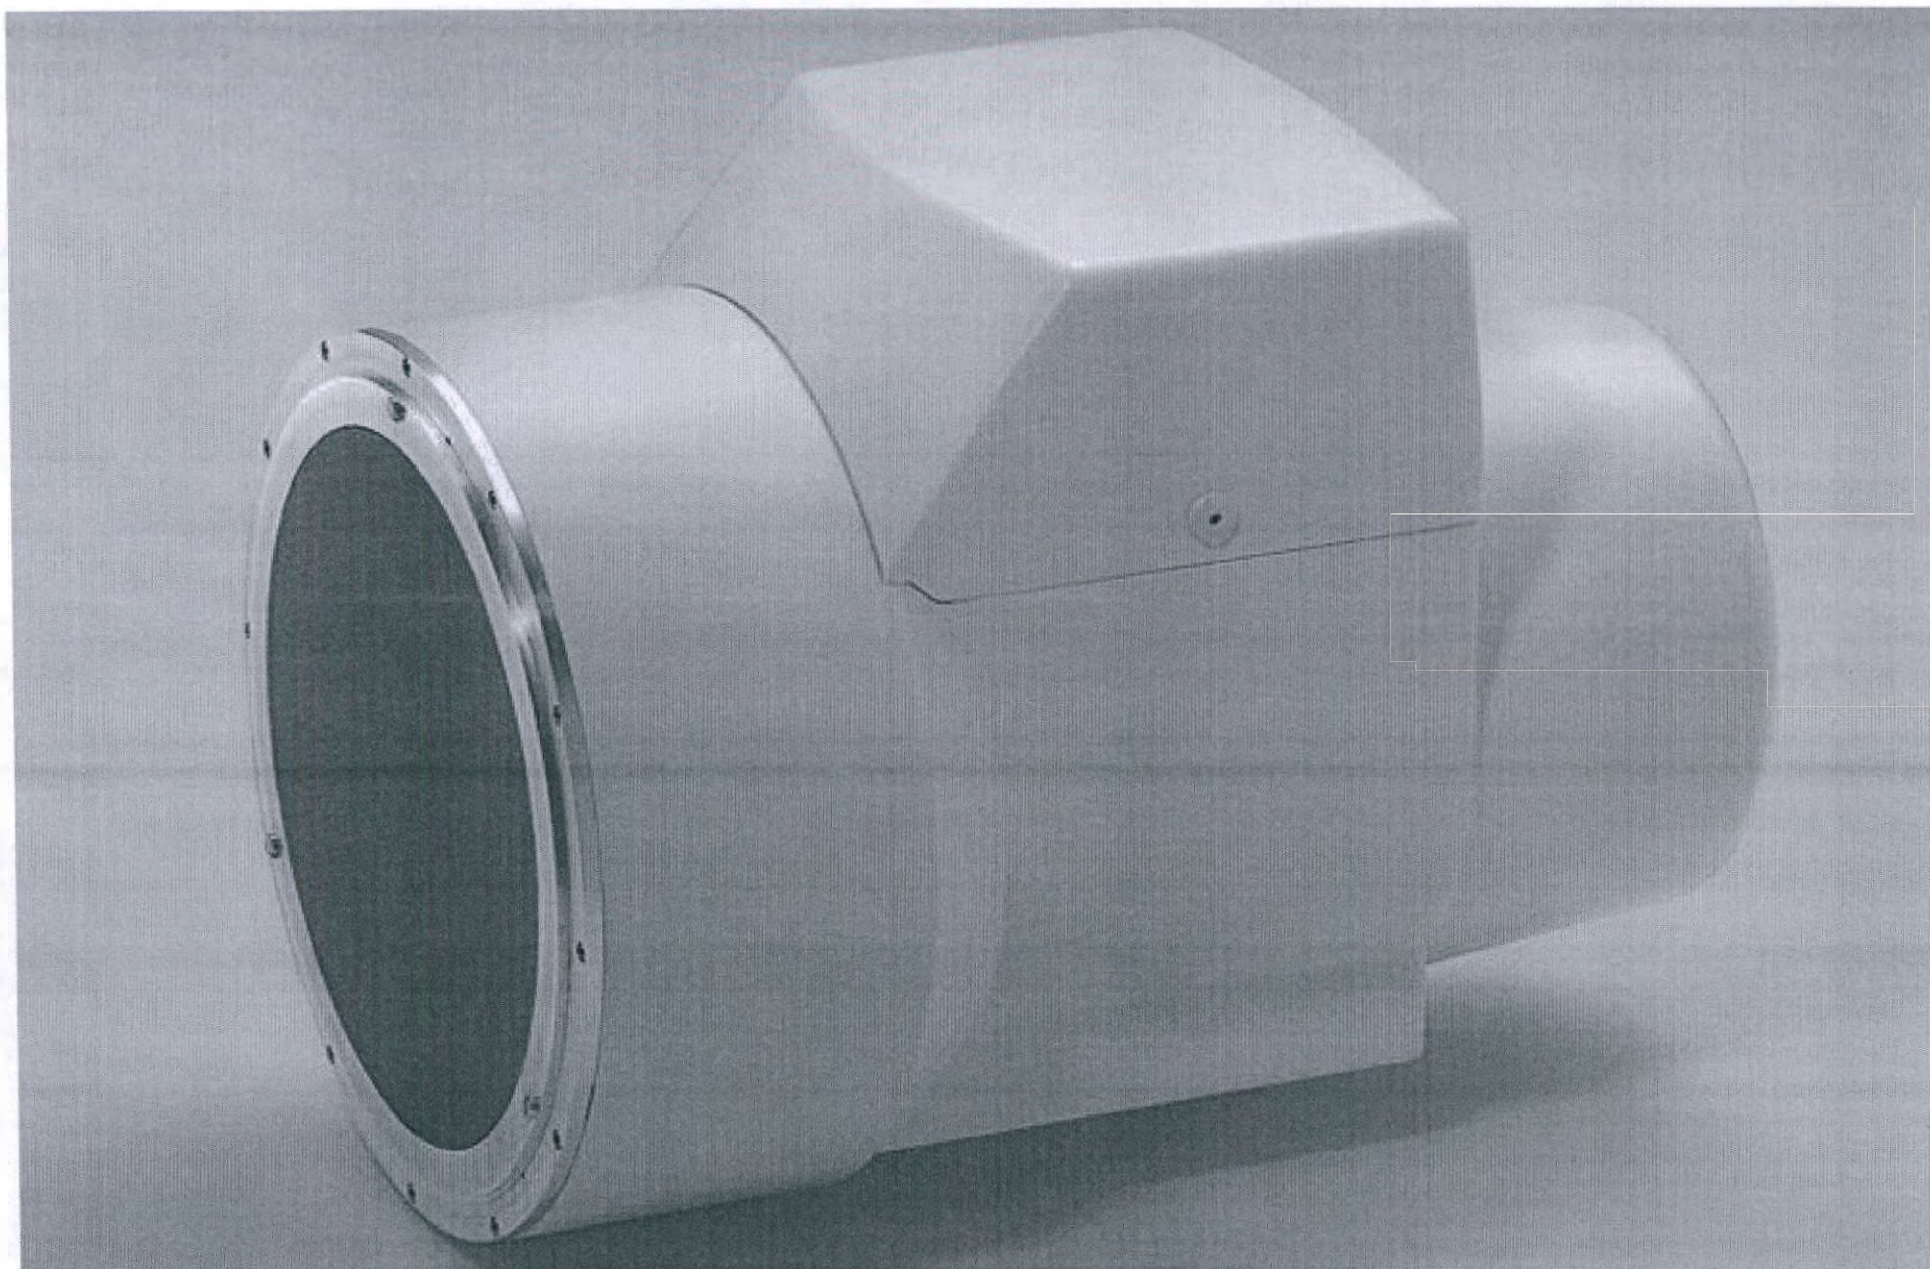

9. Камера ПЗС N производства Nical SPA, Италия;

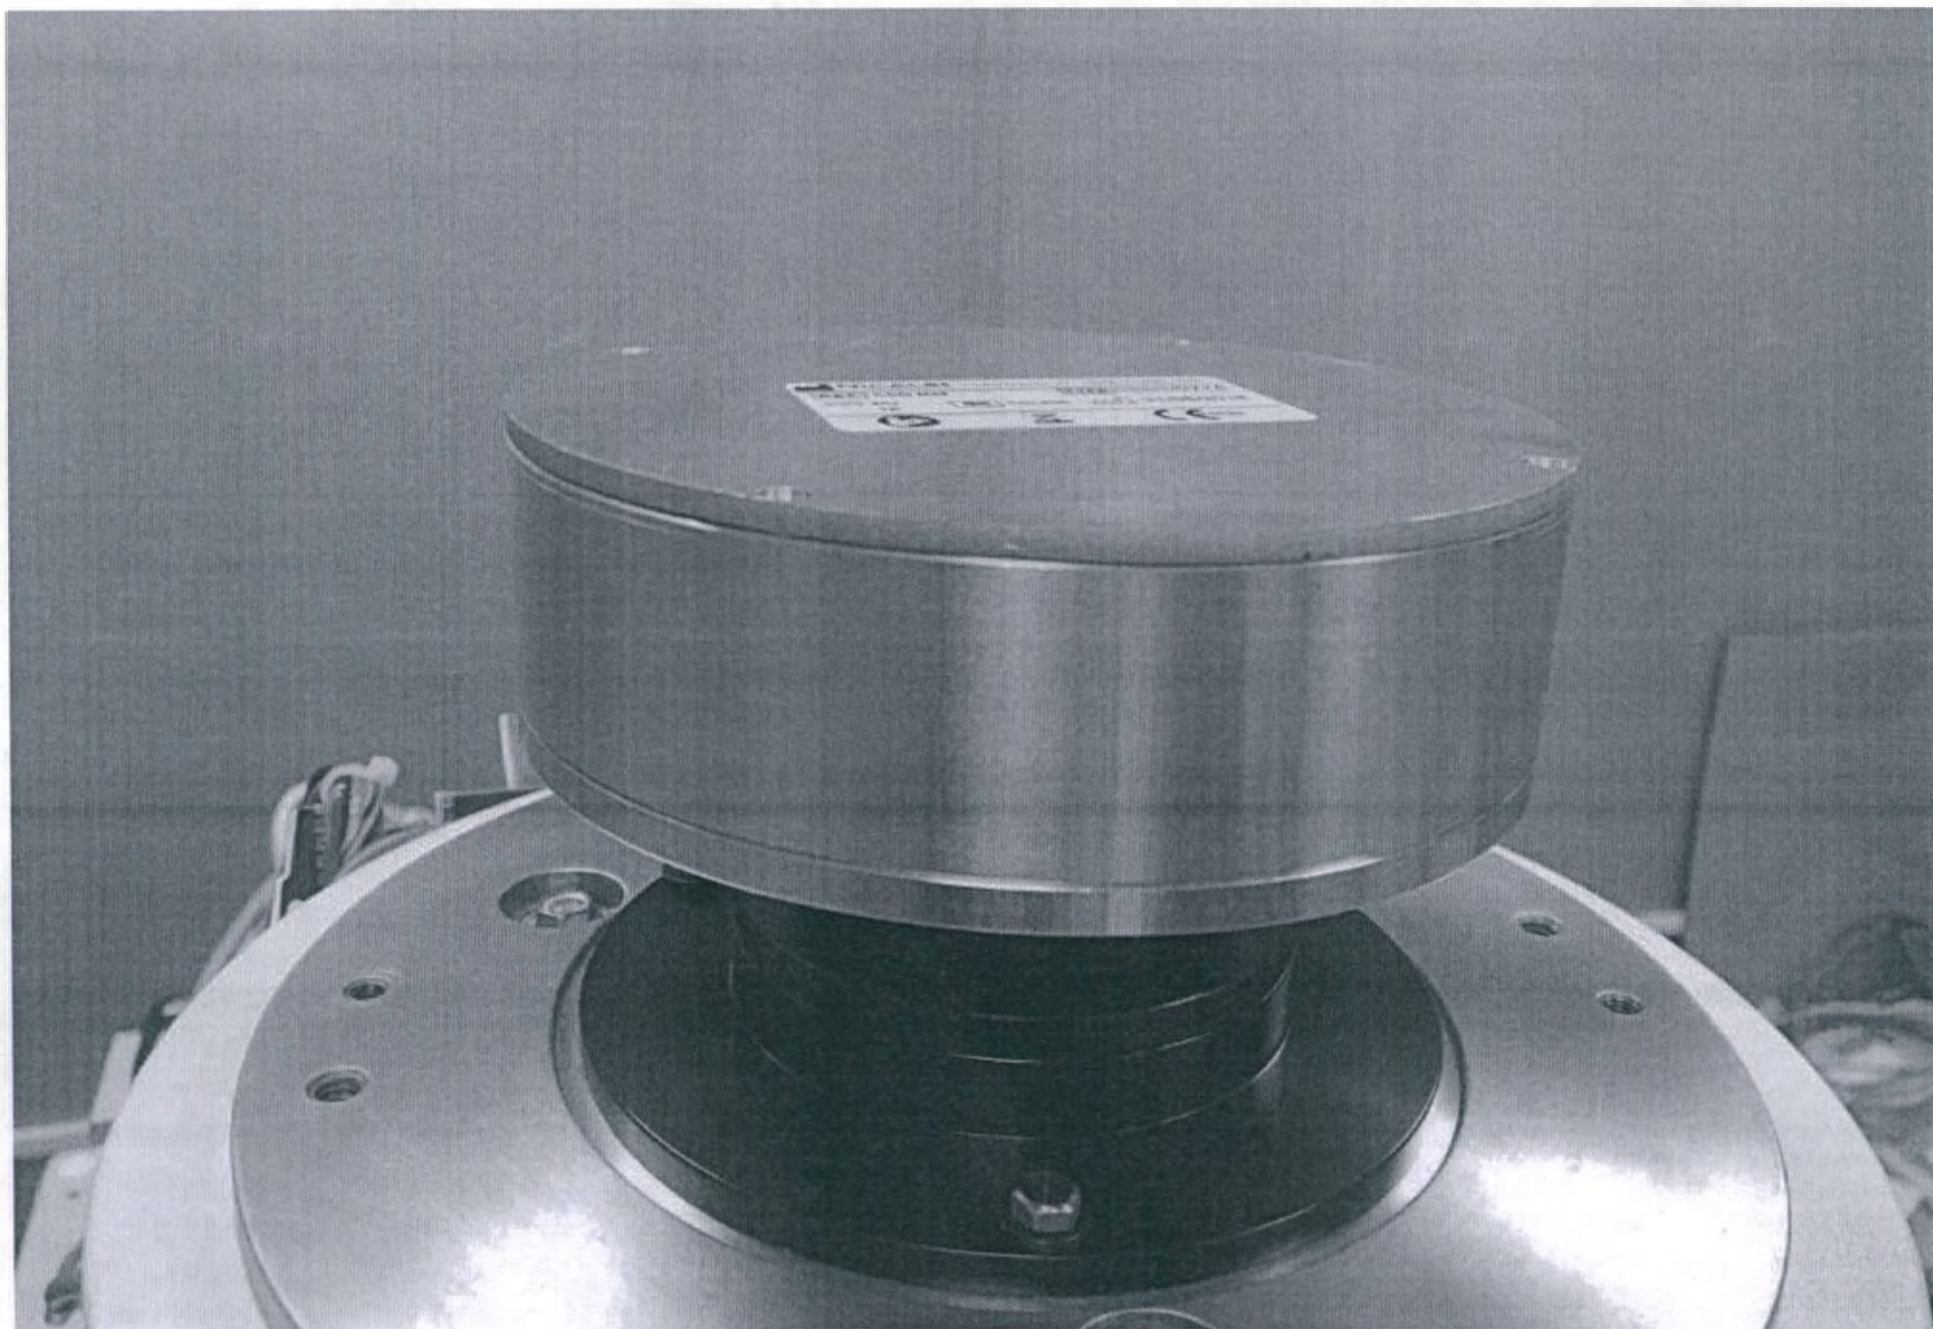


или Pearl производства Adimec Advanced Image Systems BV, Нидерланды;

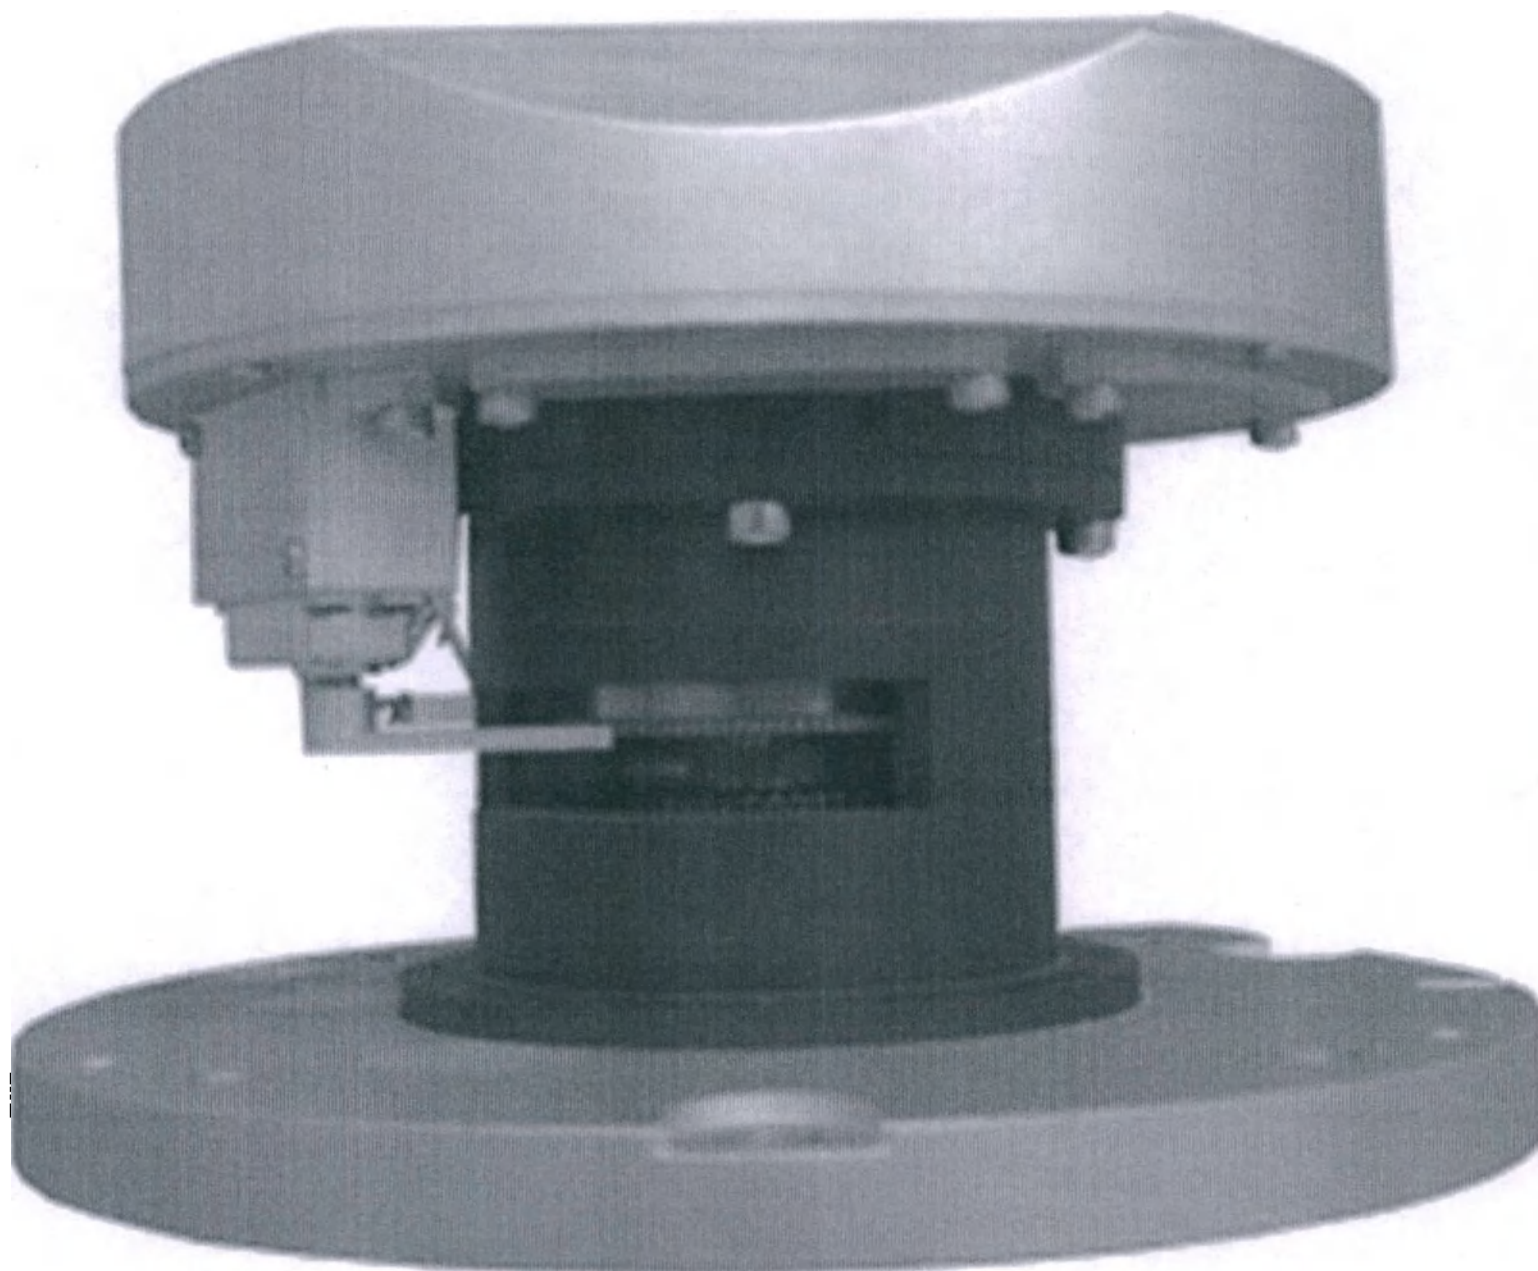


или ТН производства Thales Electron Devices SAS, Франция;




или HIDEQ производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

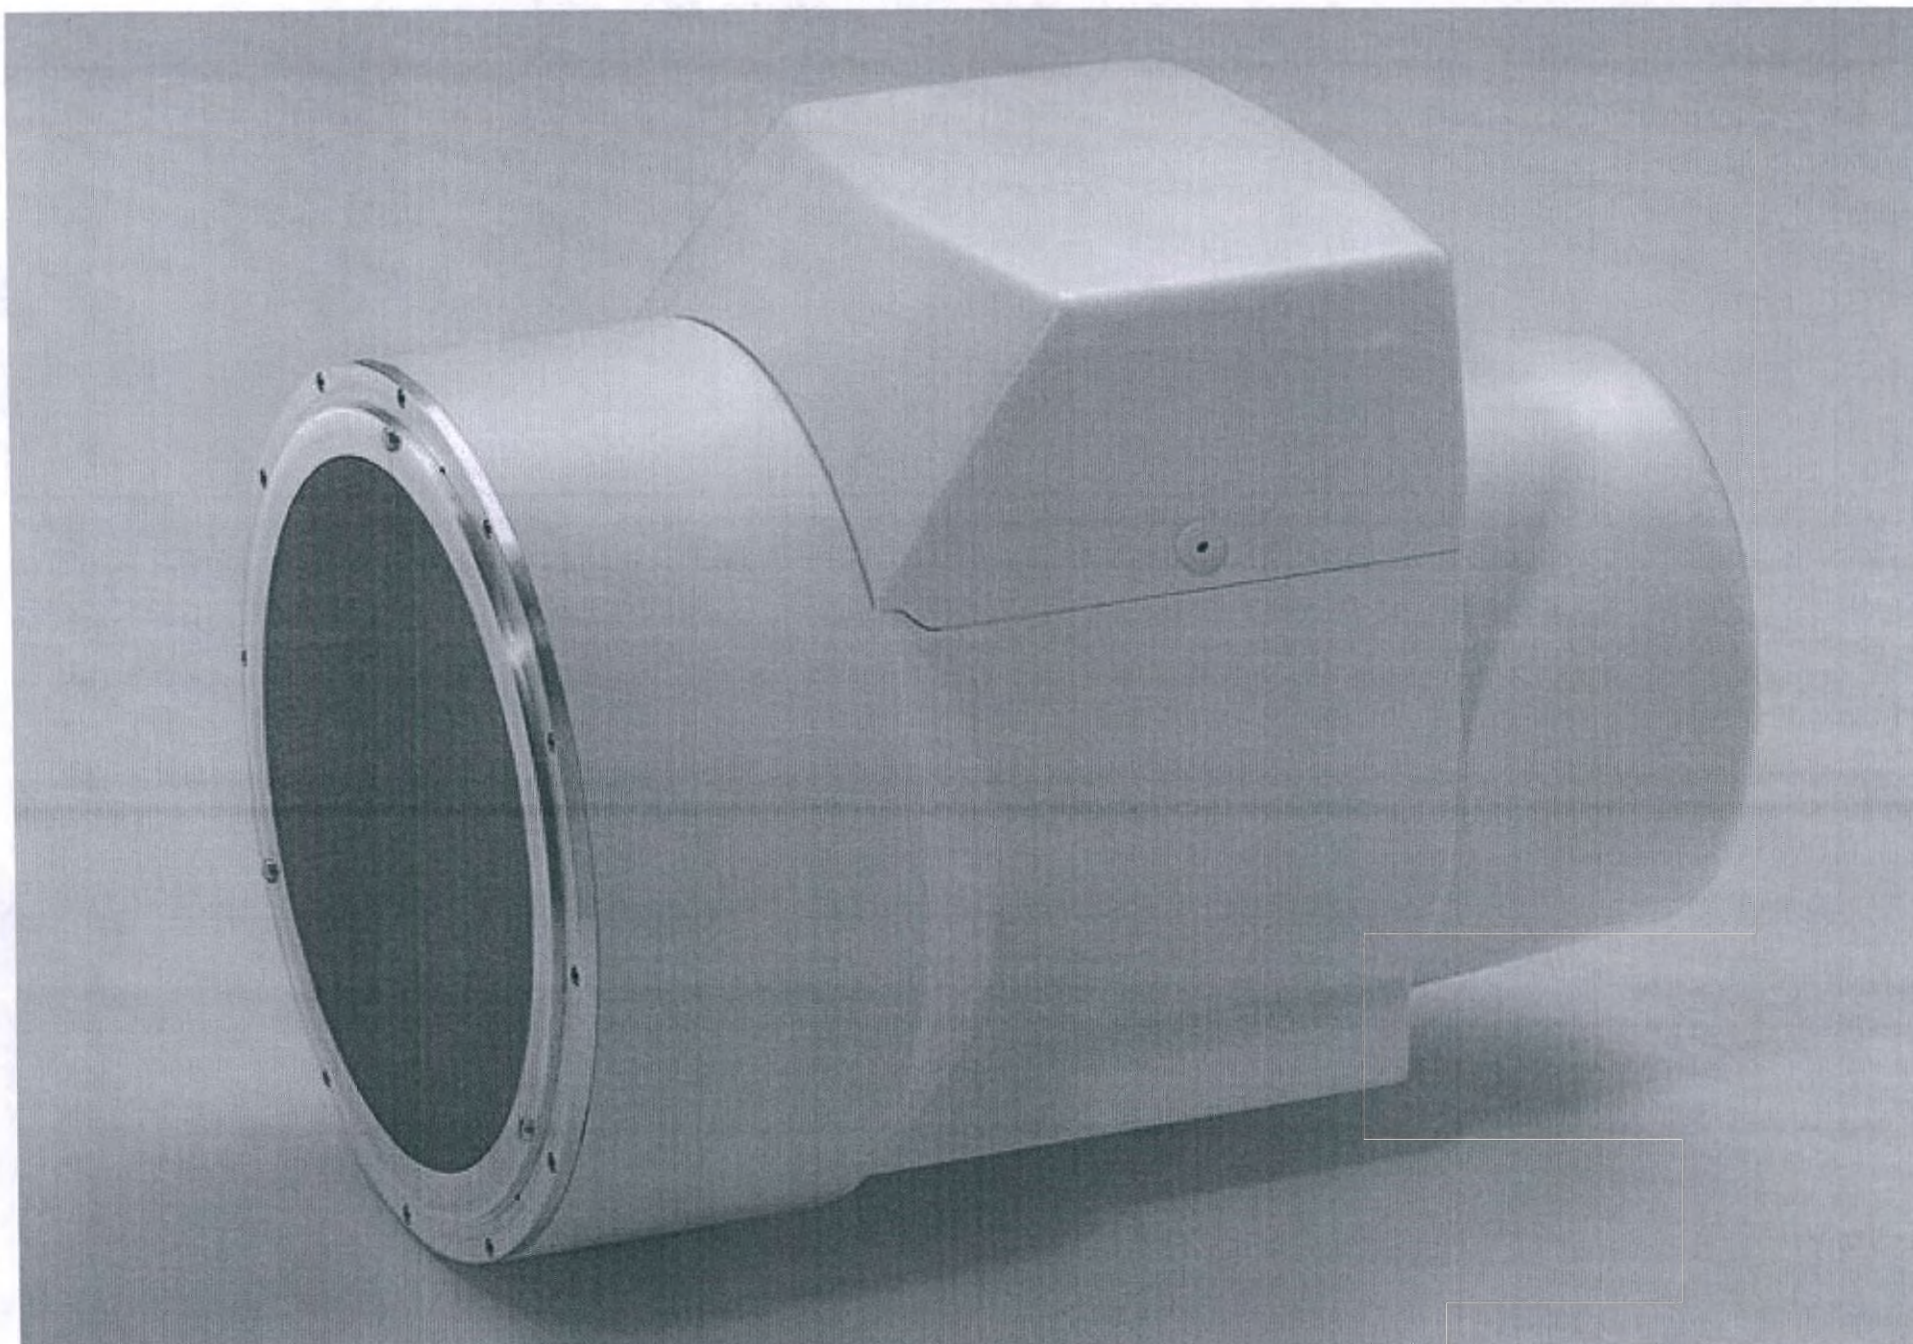



10. Стойка для рентгенографии IMX производства Imago Radiology S.r.l. Италия;

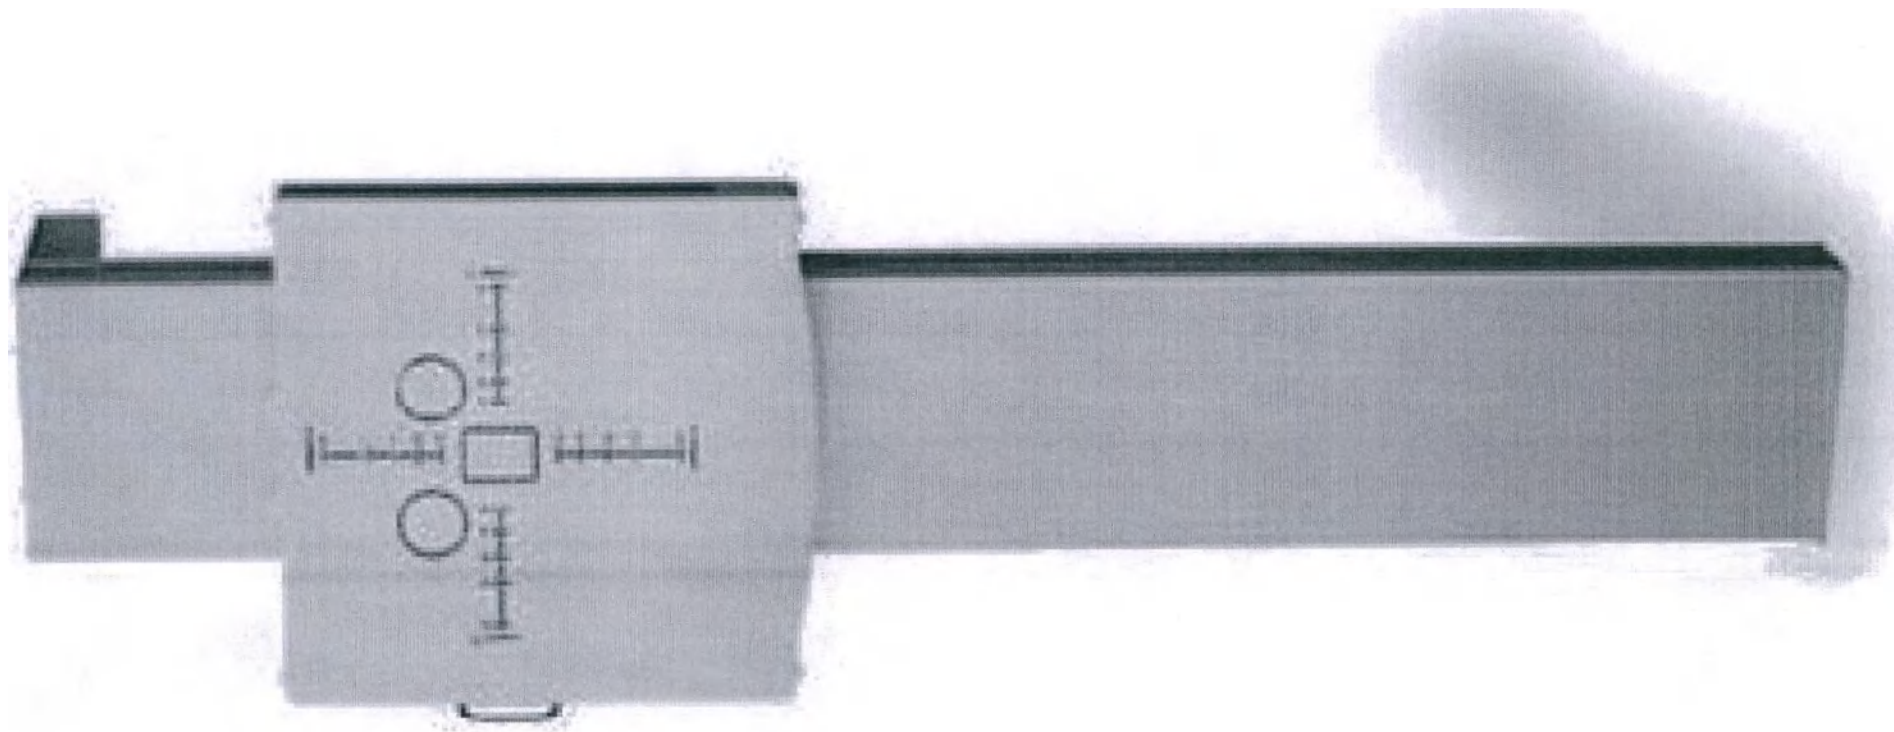


или Millenium производства Sociedad Espanola de Electromedicina y Calidad, S.A. (Sedecal), Испания;

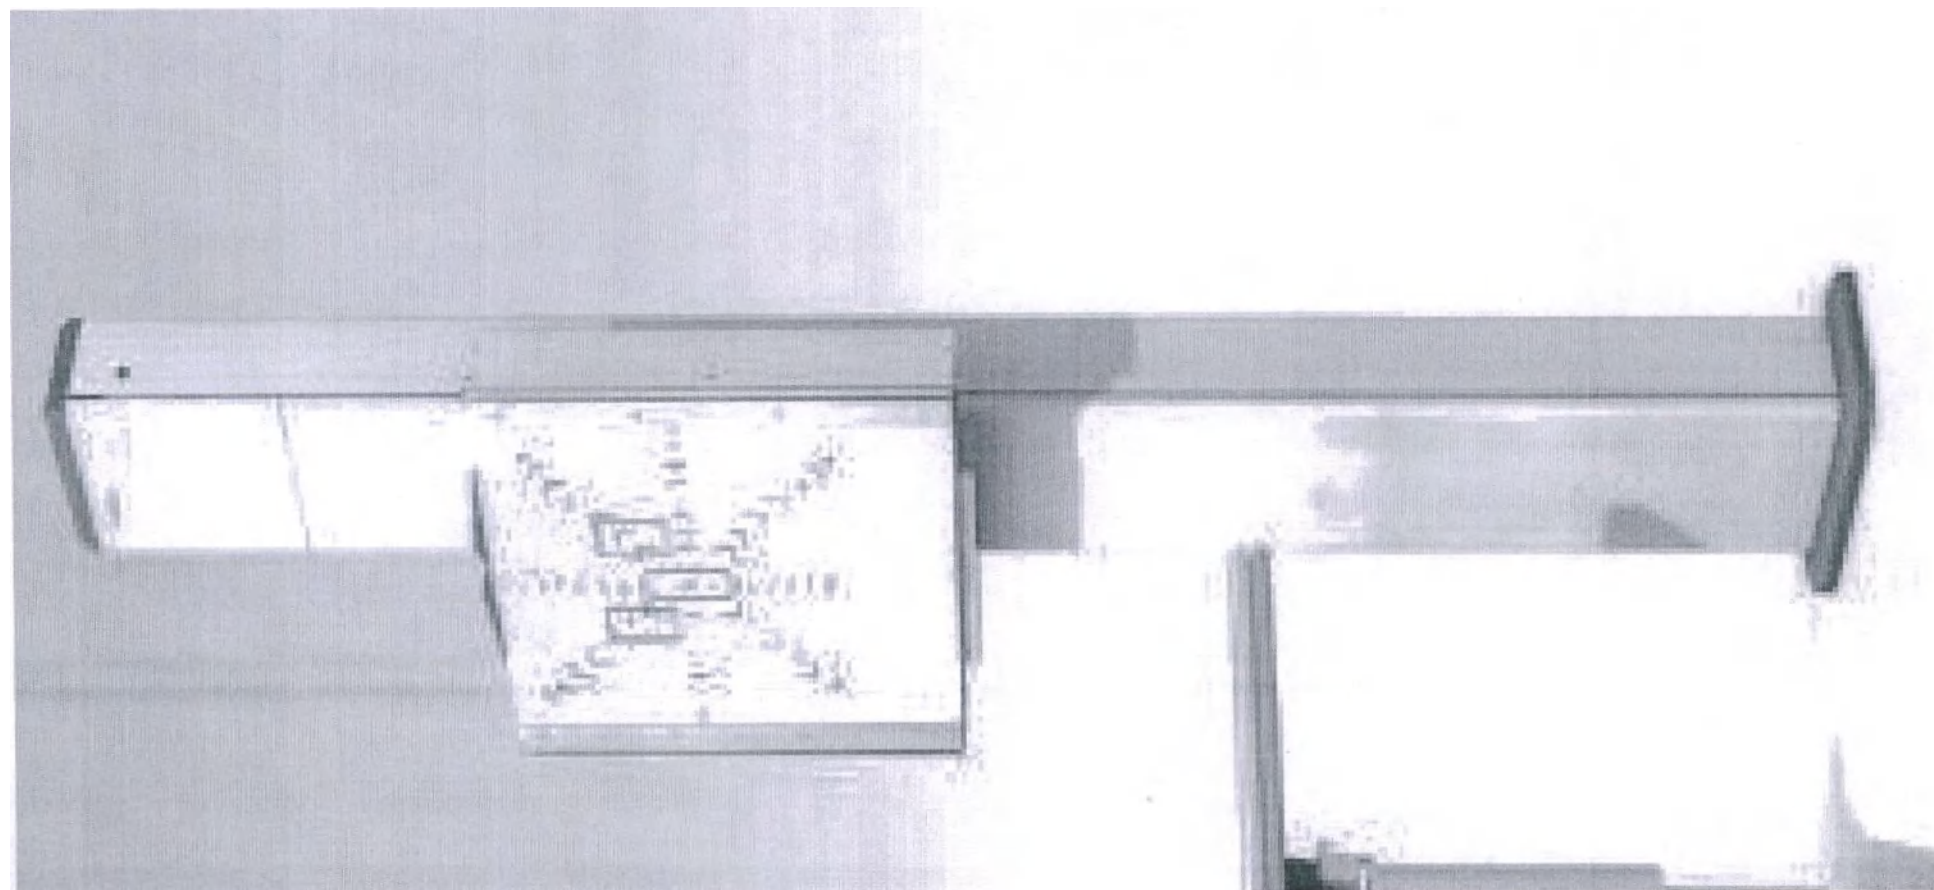


или RS производства General Medical Merate SPA (GMM) Италия;

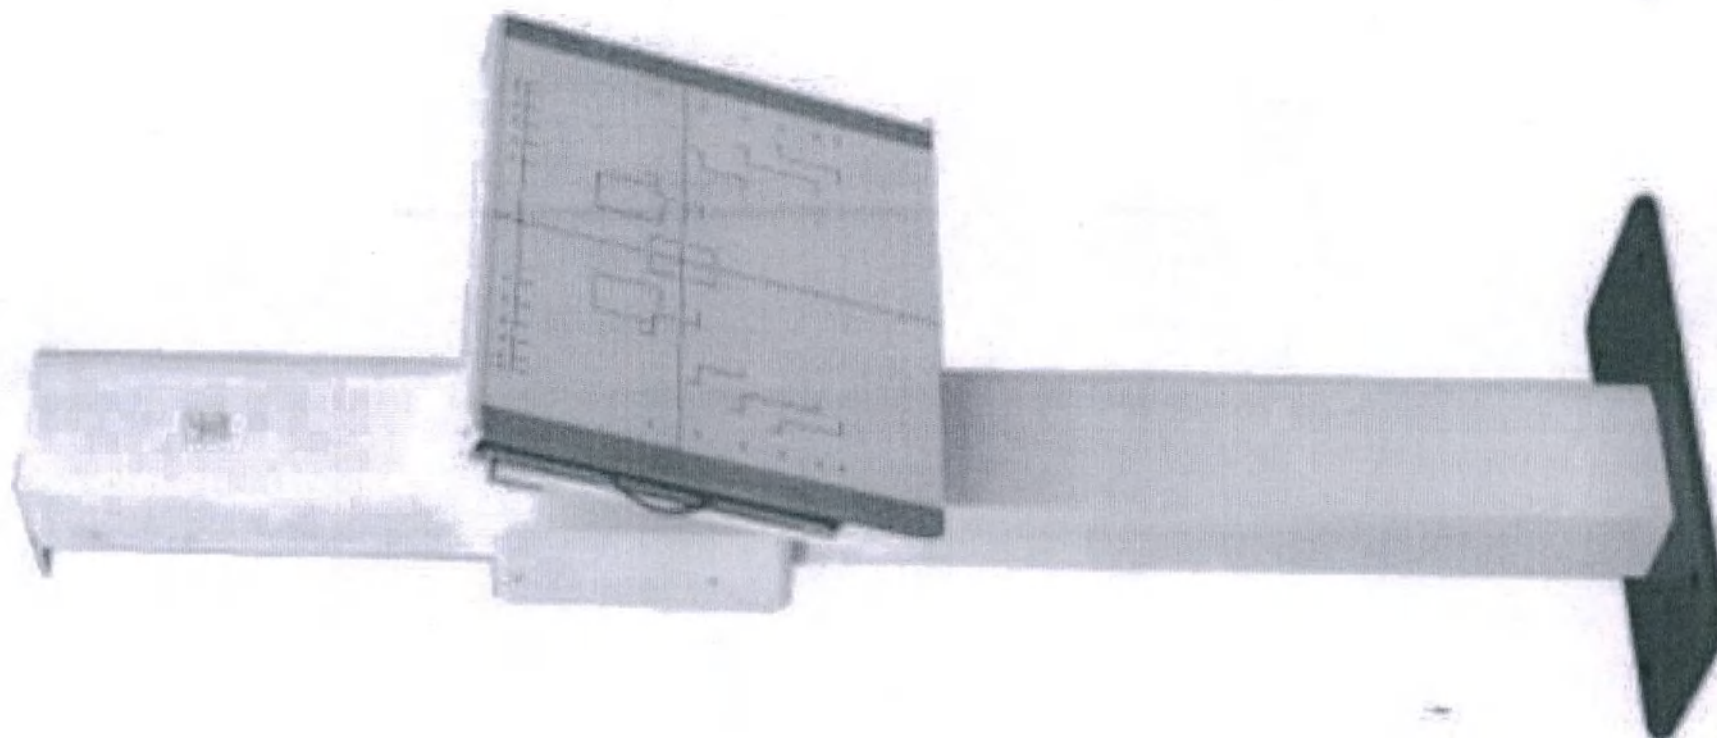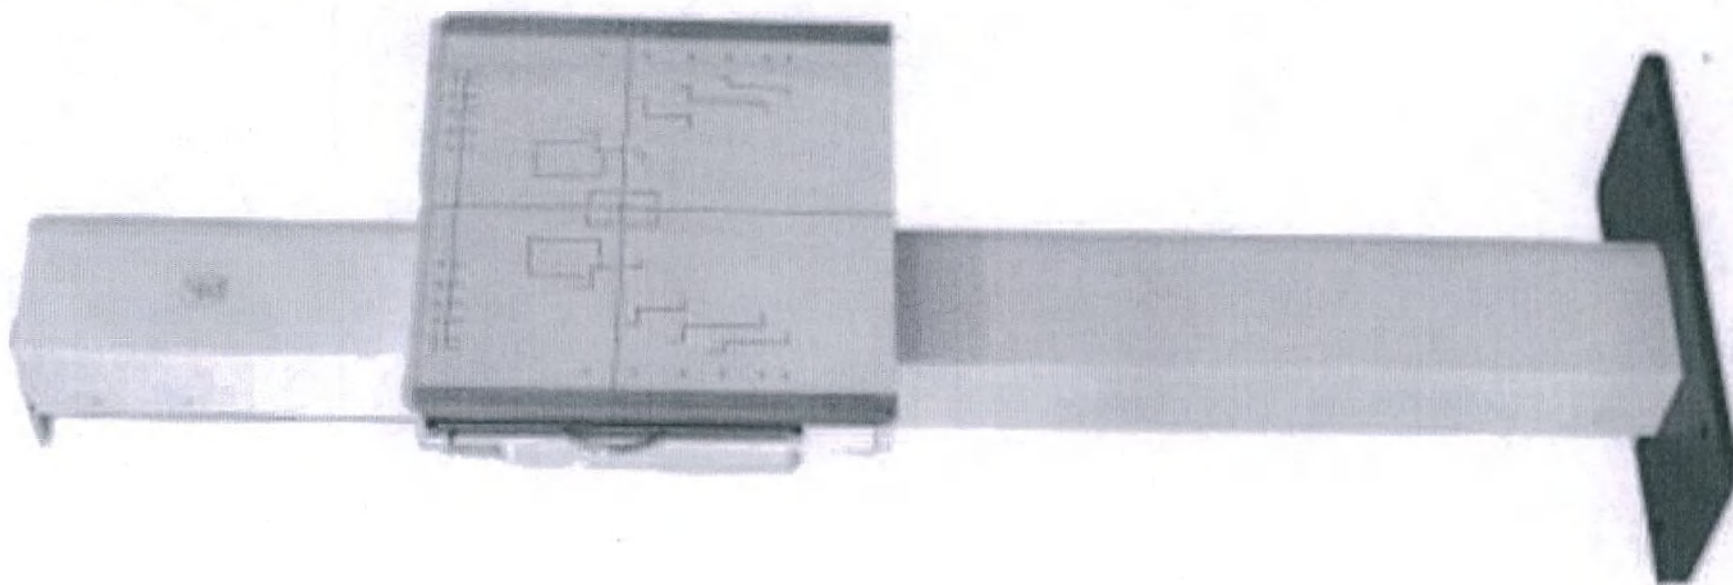


или АДН производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

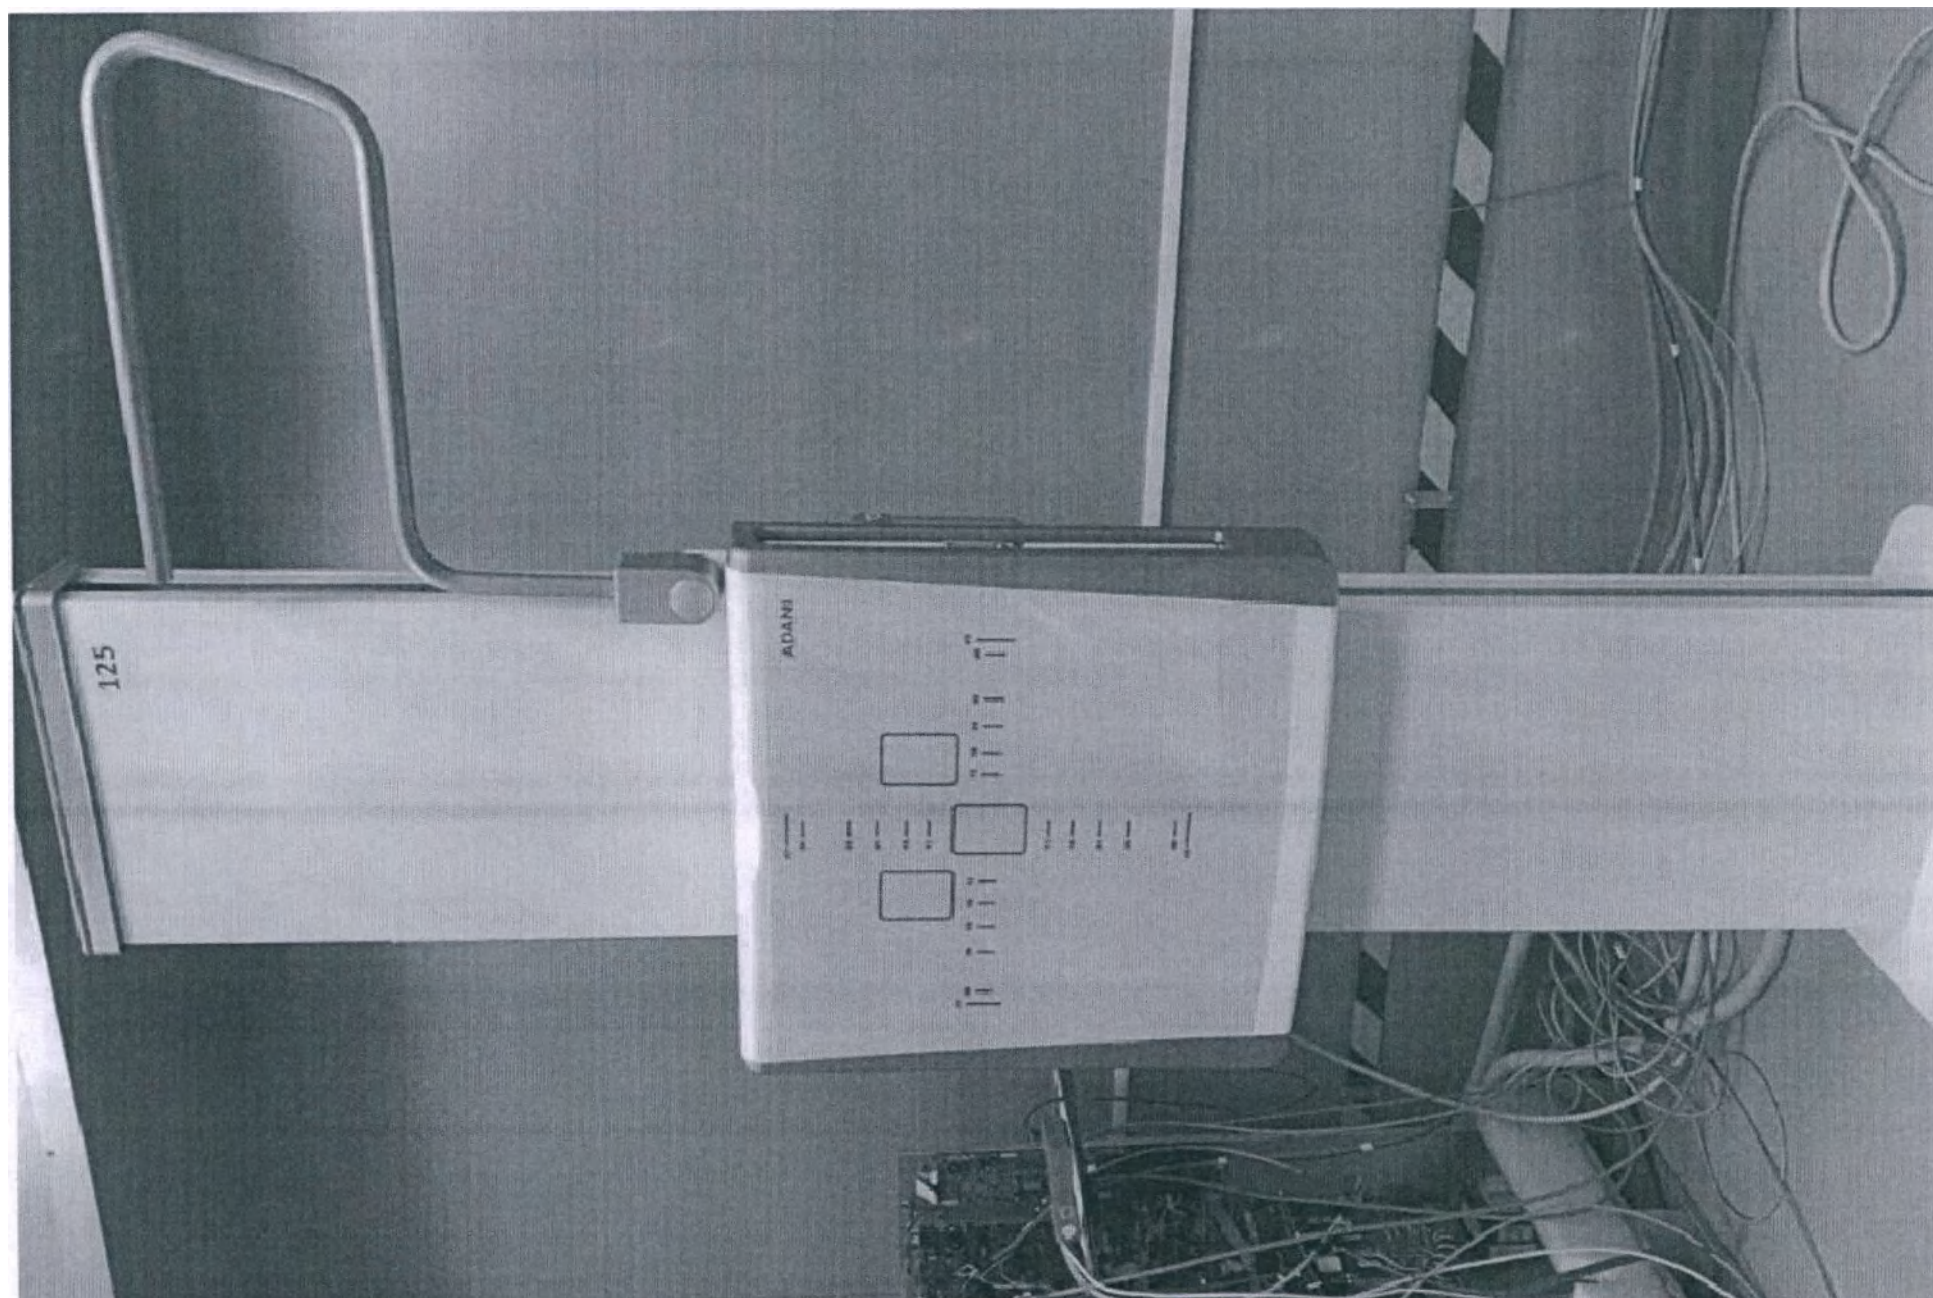

или производства Diagnostic Medical System Apelem, Франция;

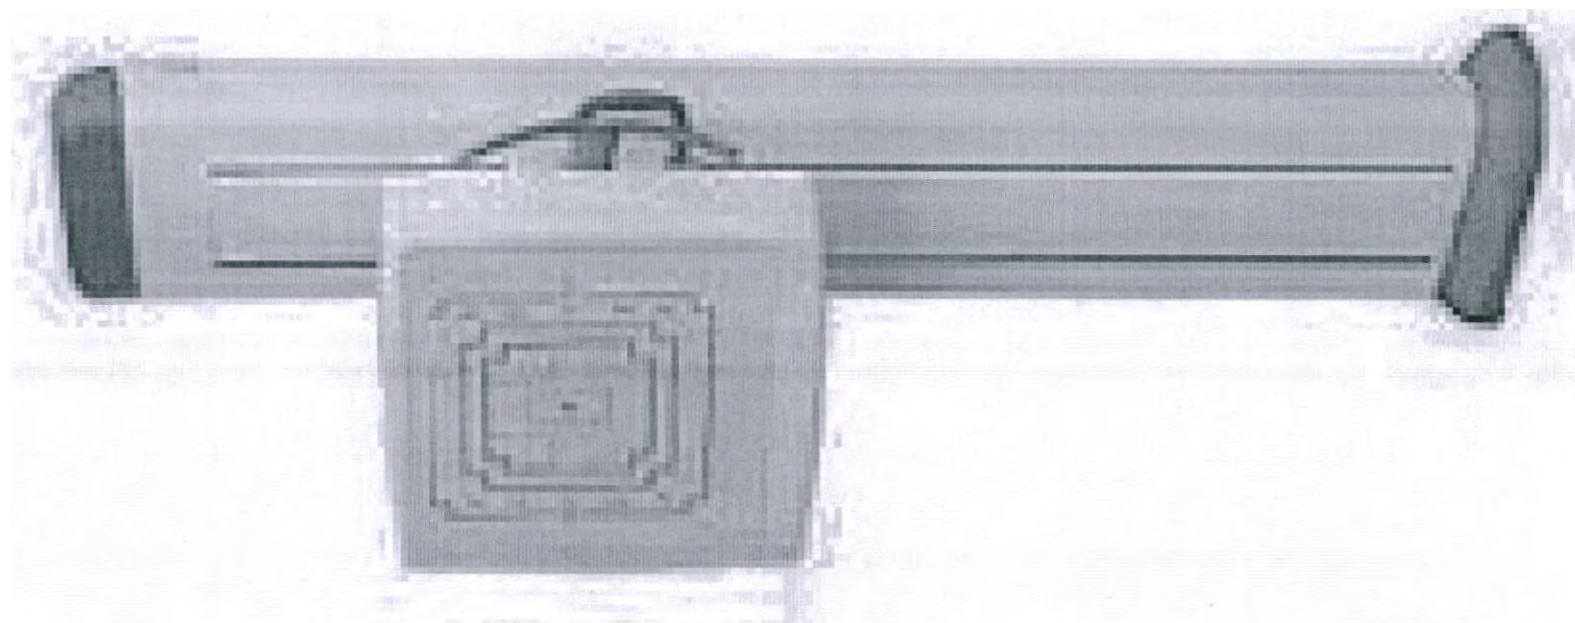


или WS производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

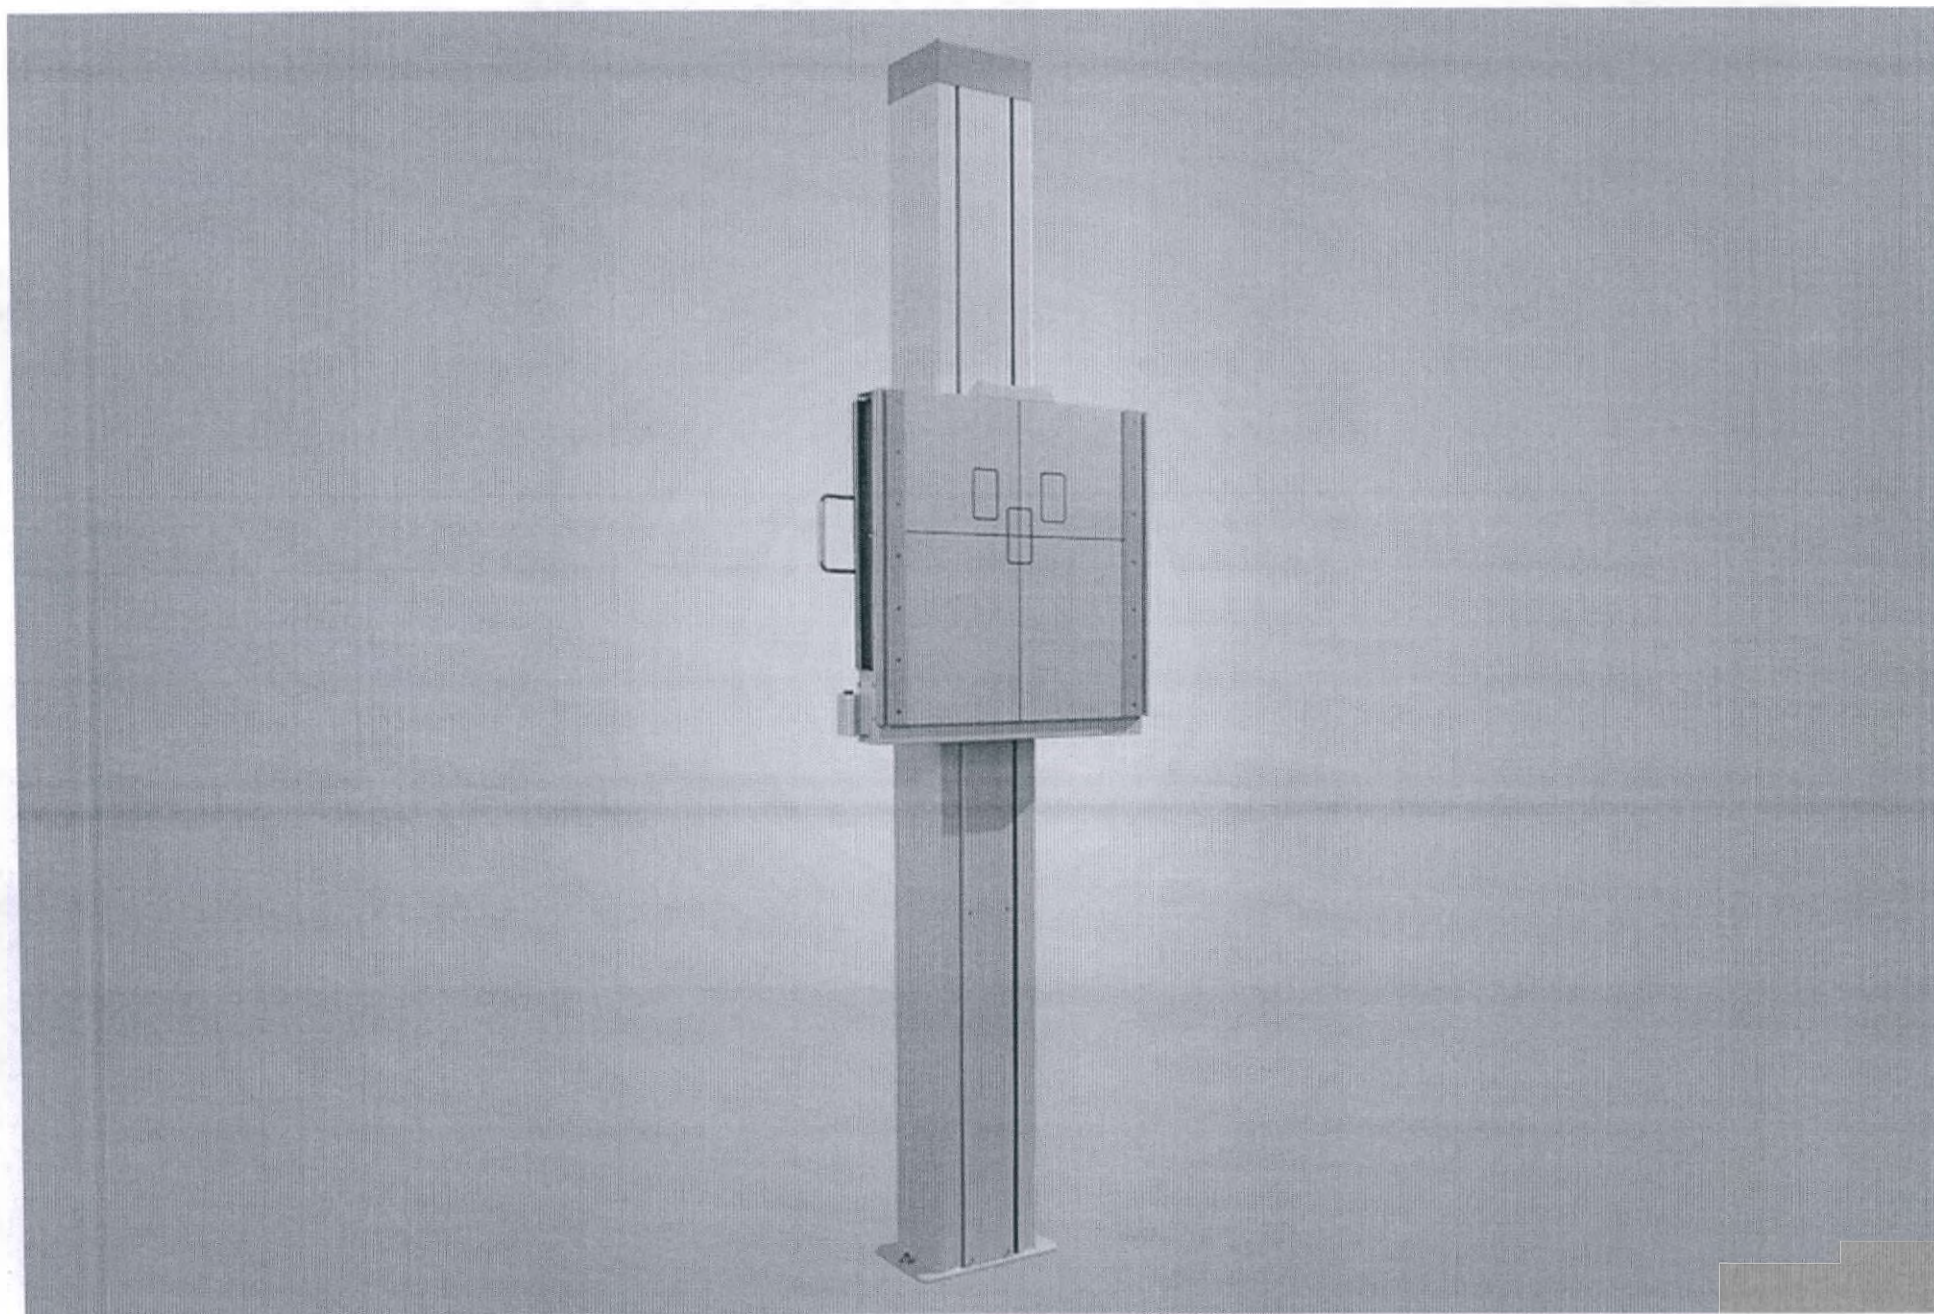


11. Комплект эксплуатационной документации.


12. Анти-рассеивающая решетка производства JPI Healthcare Co, Ltd, Республика Корея;

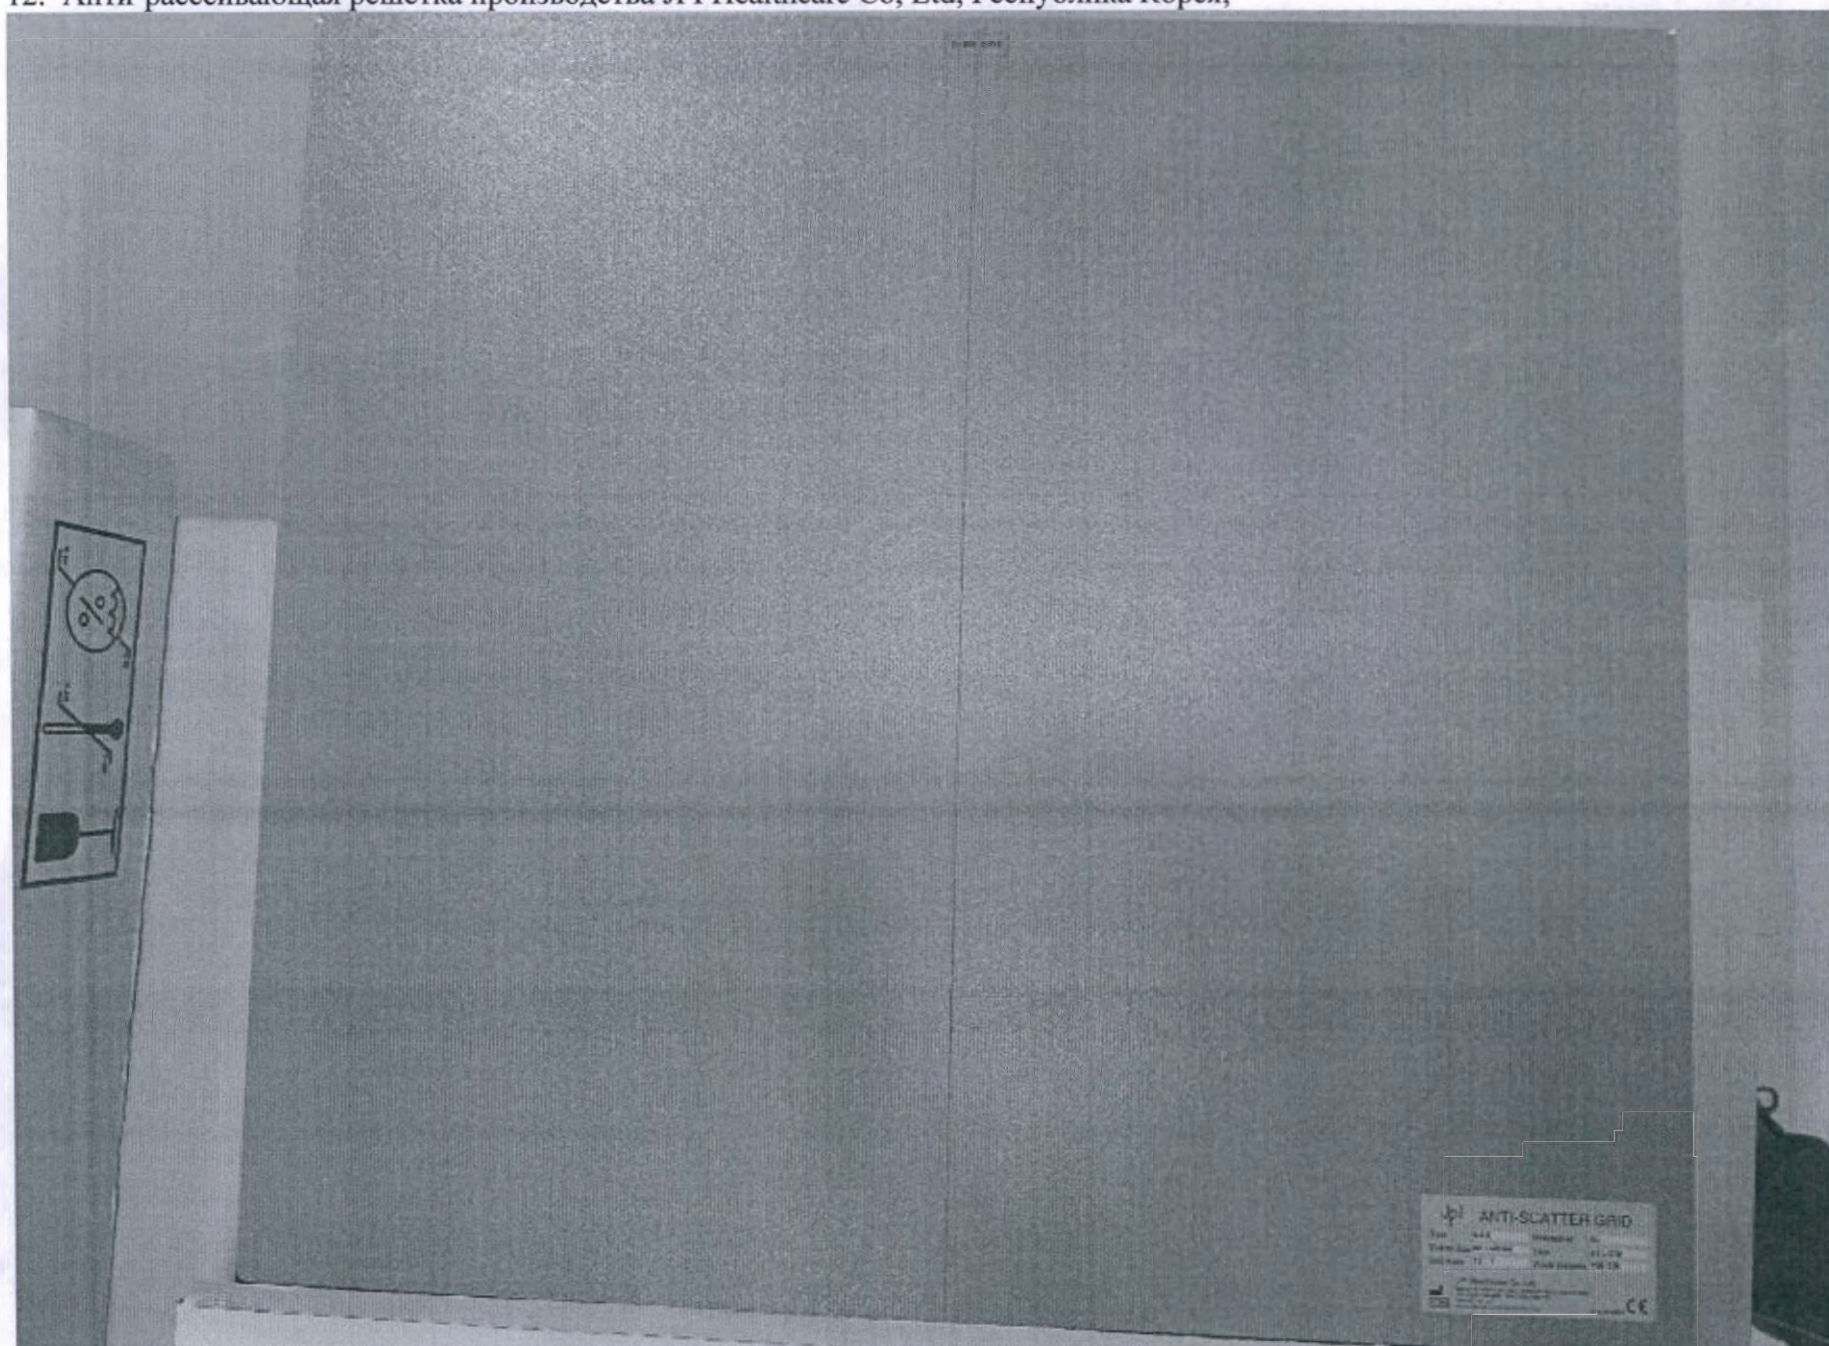


или производства Gilardoni S.p.A, Италия;

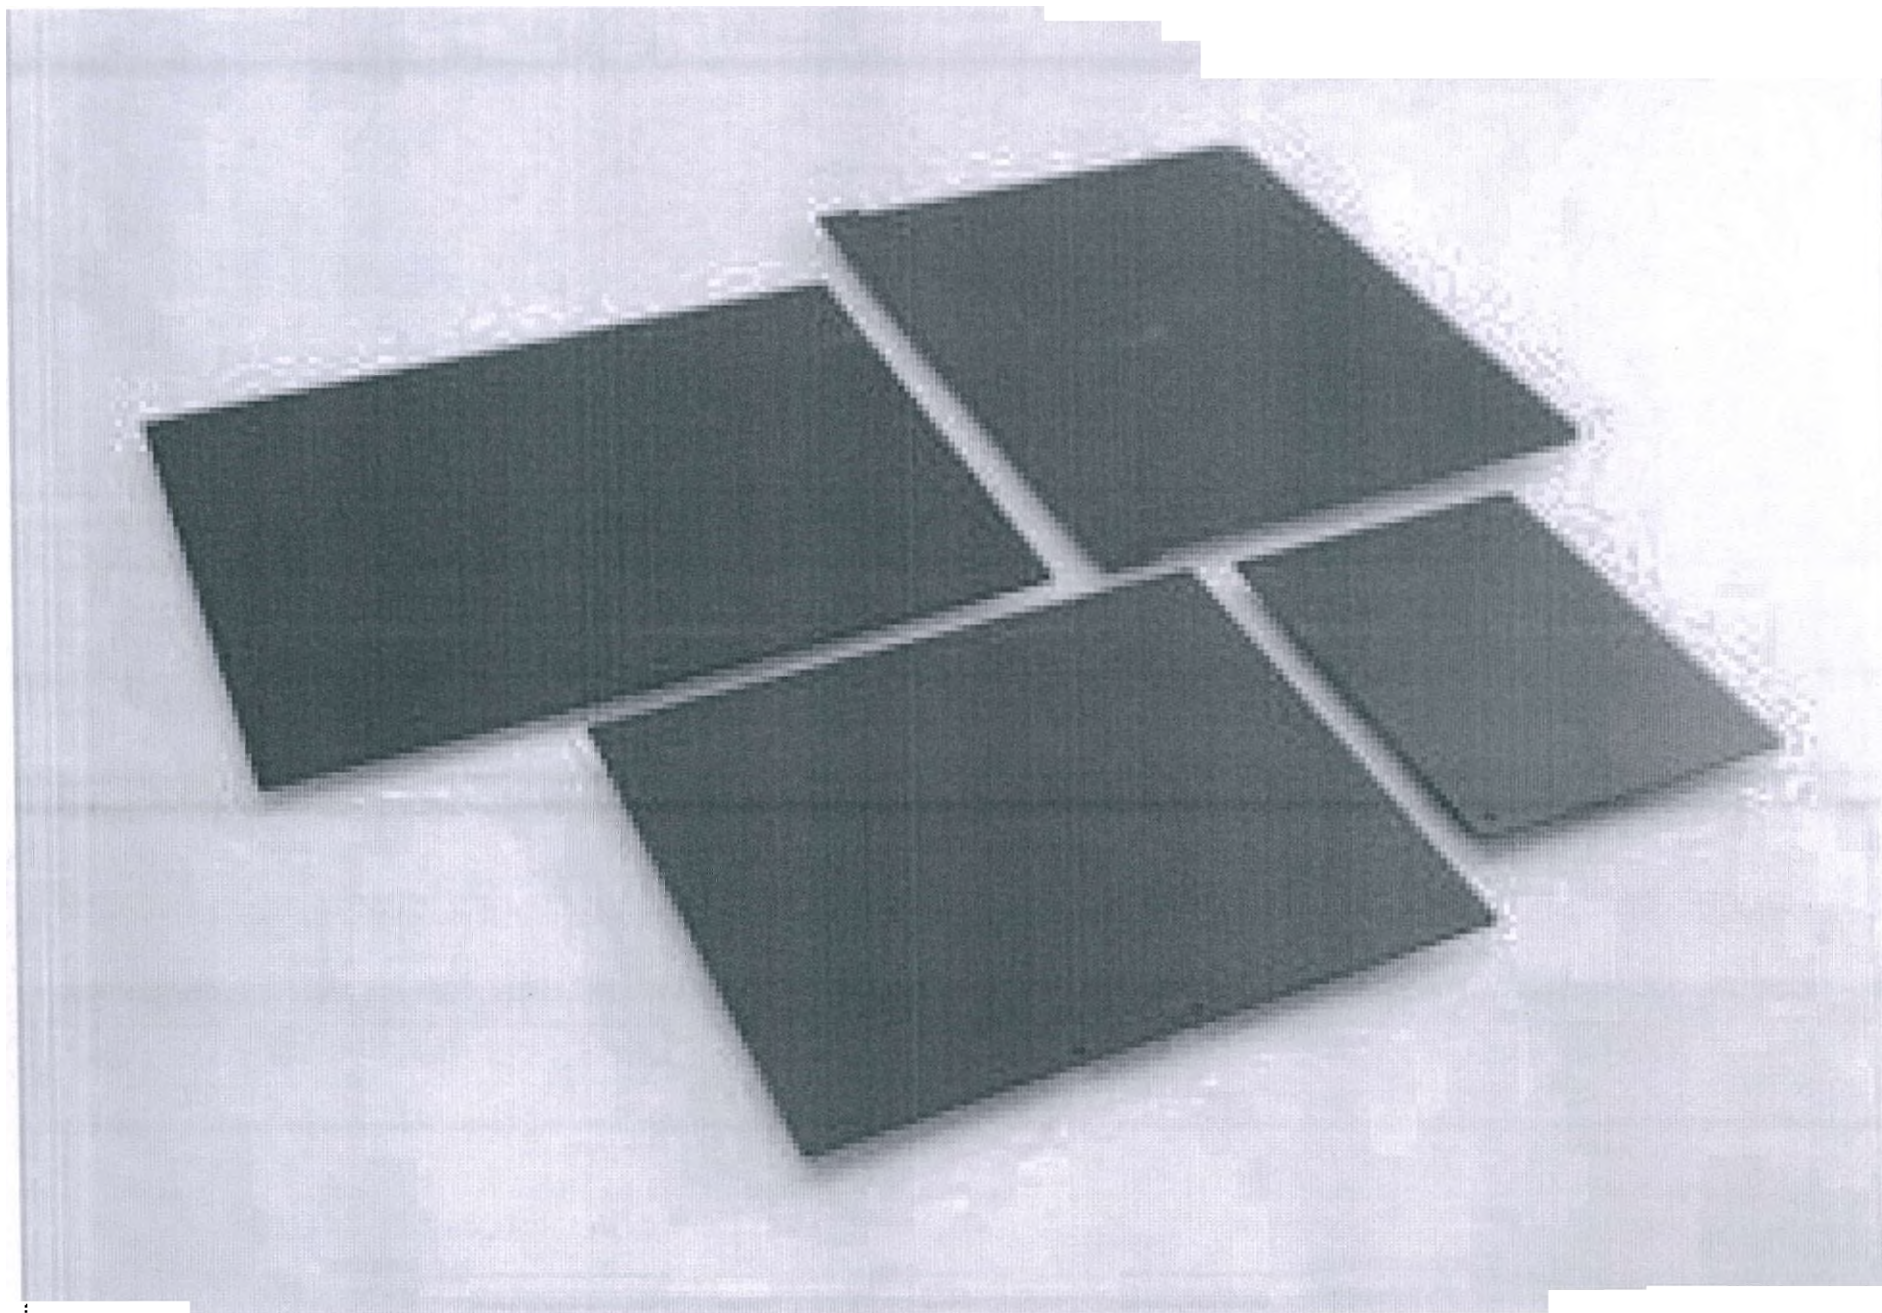


или Ysio производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

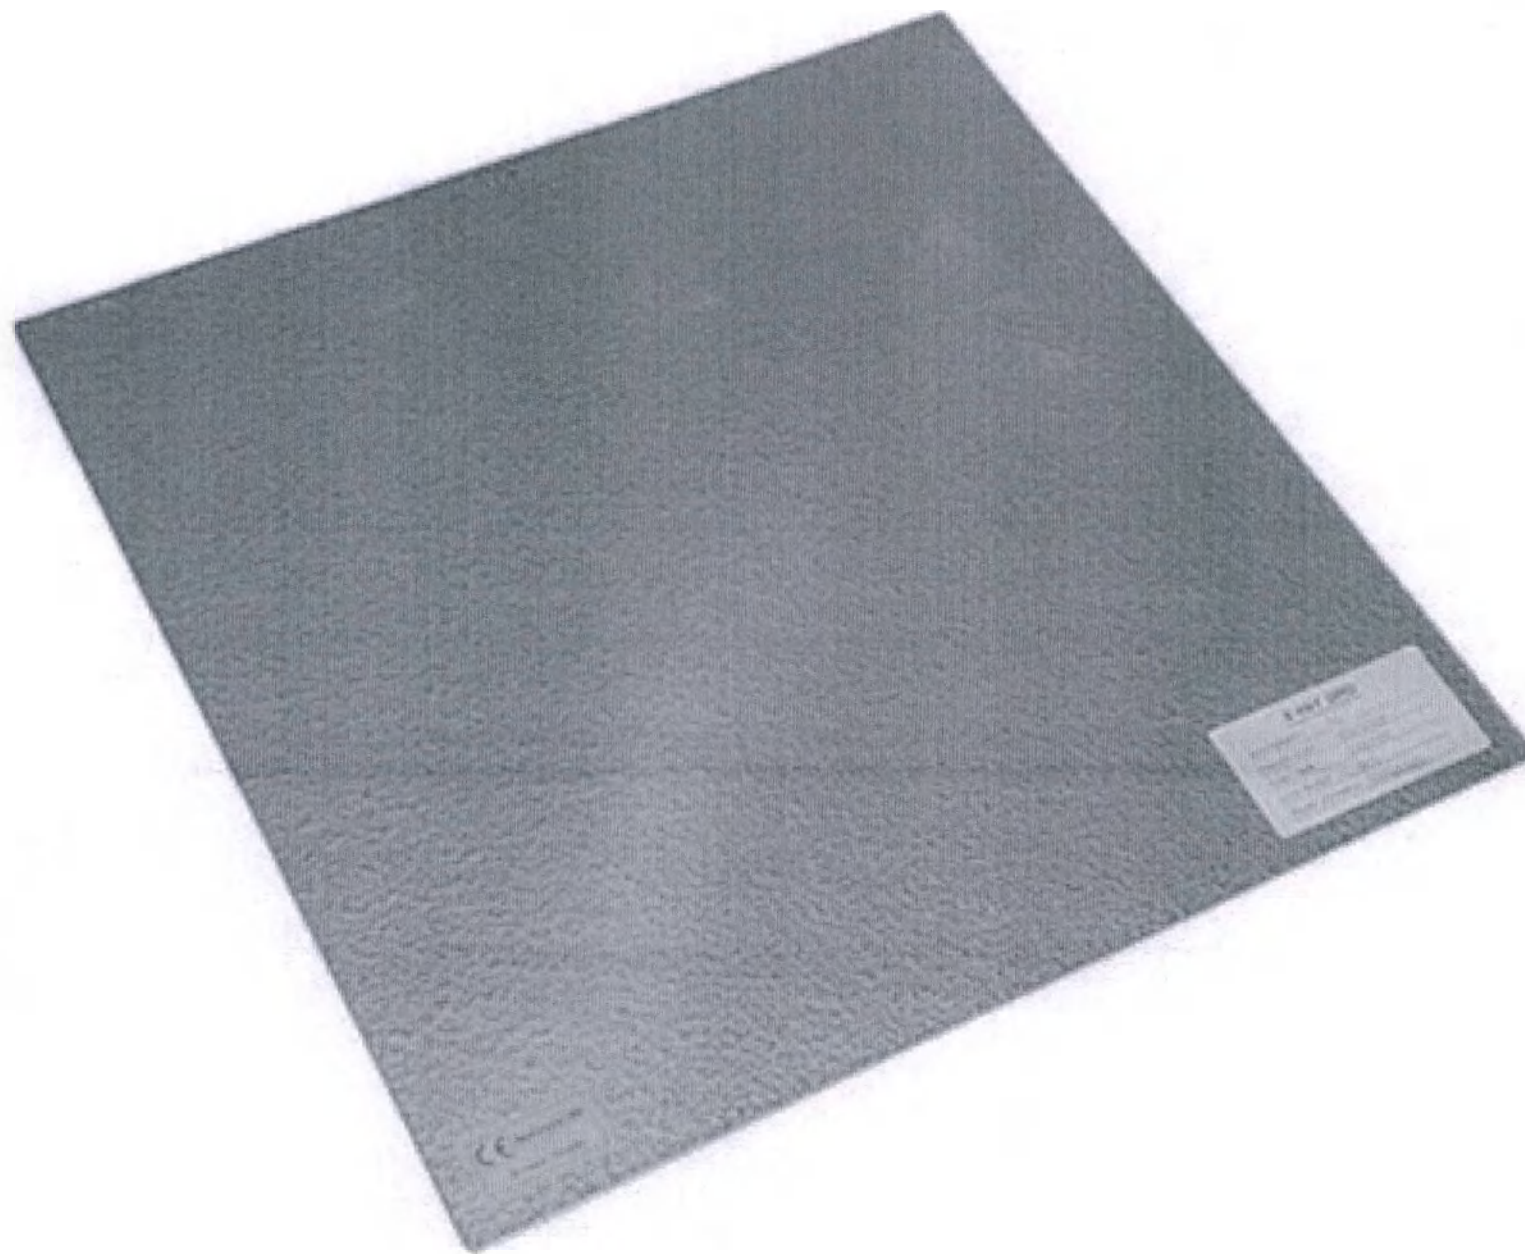


13. Камера ионизационная производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия; или SSMC;

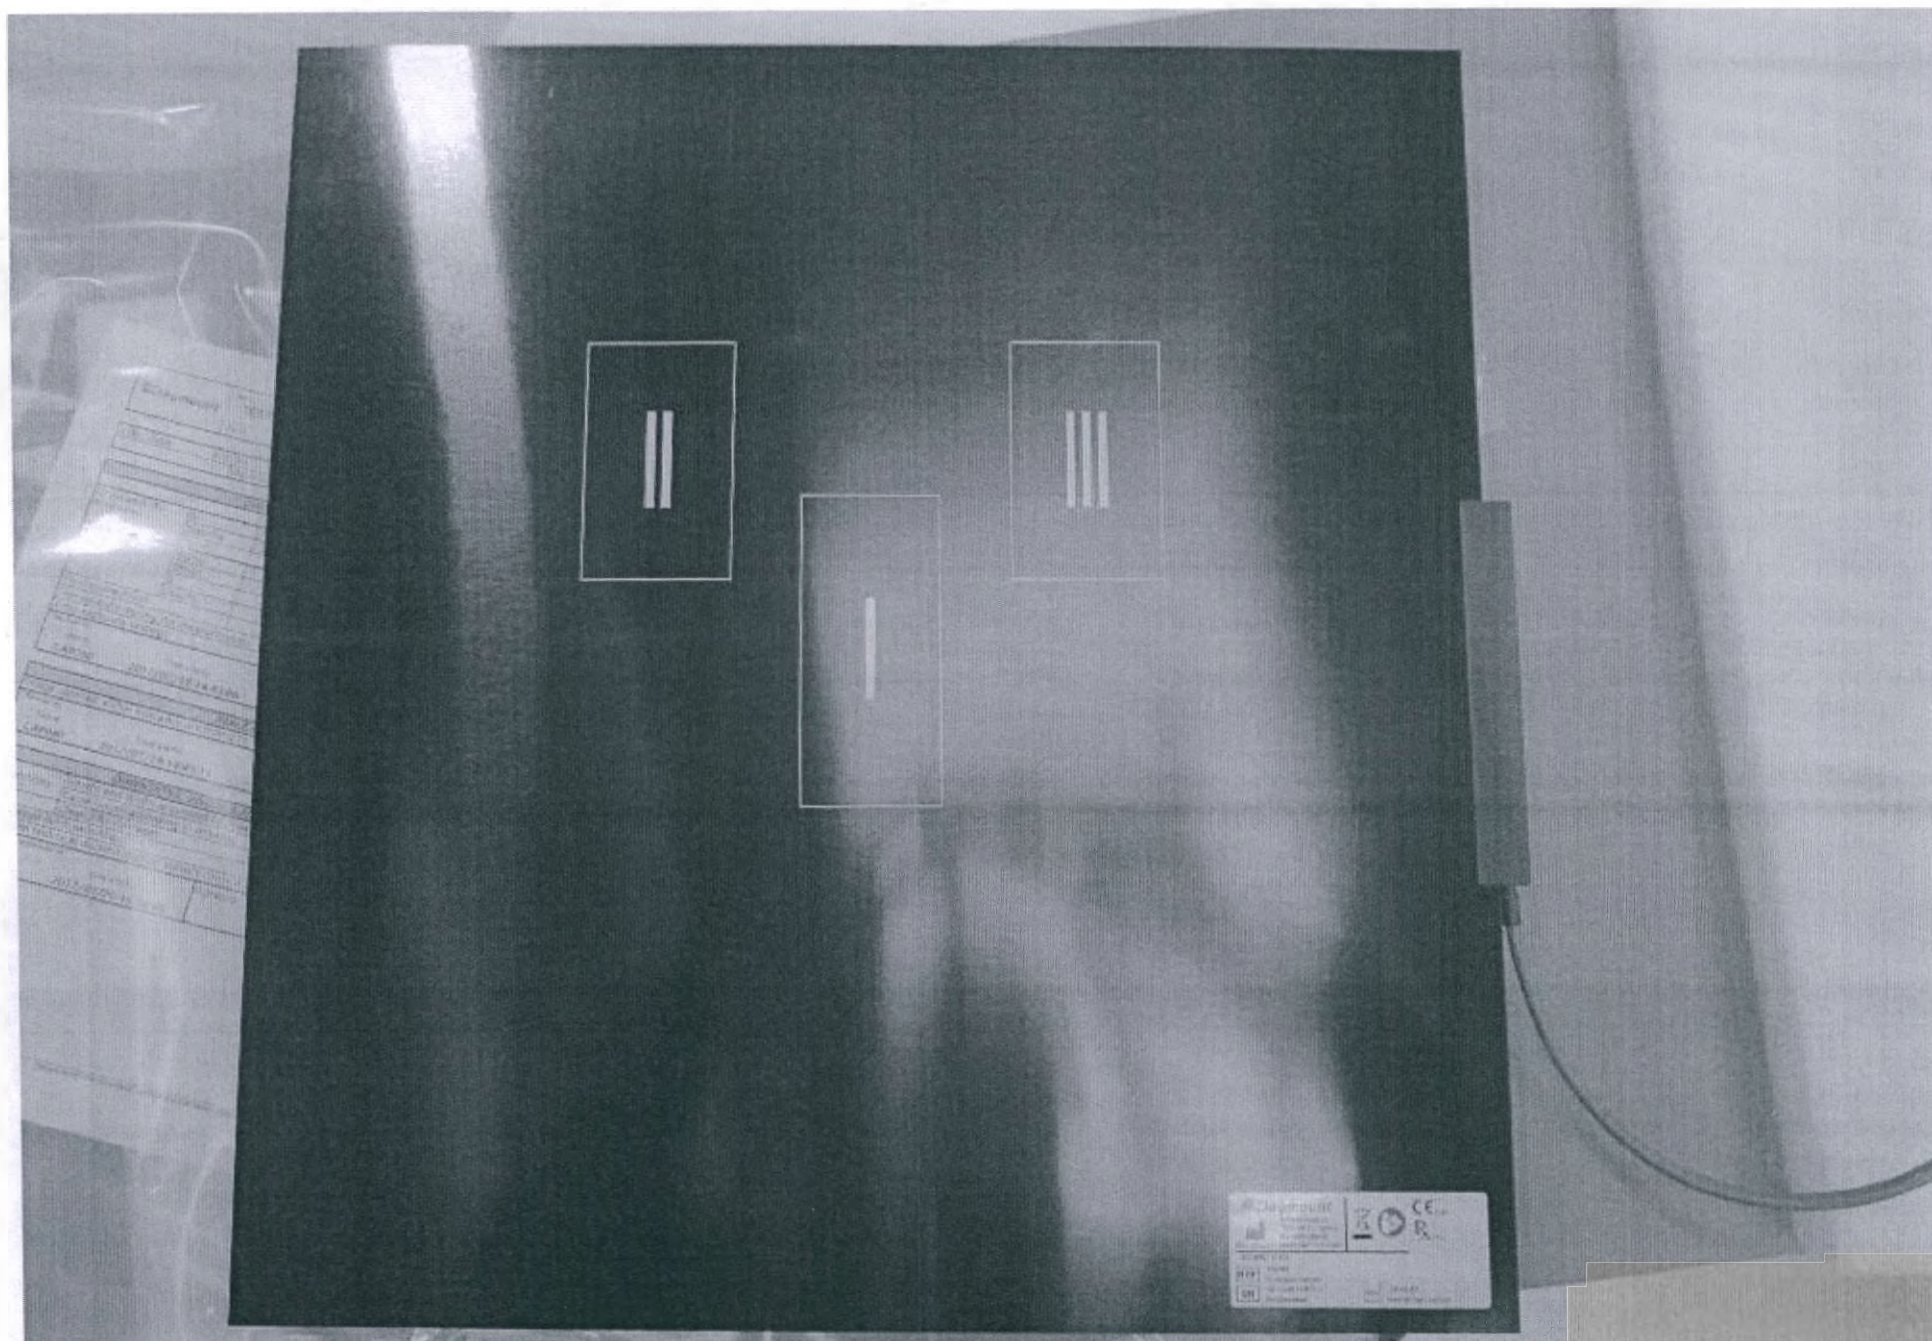


или SSMC; ICX В производства Varex Imaging Corporation, США;

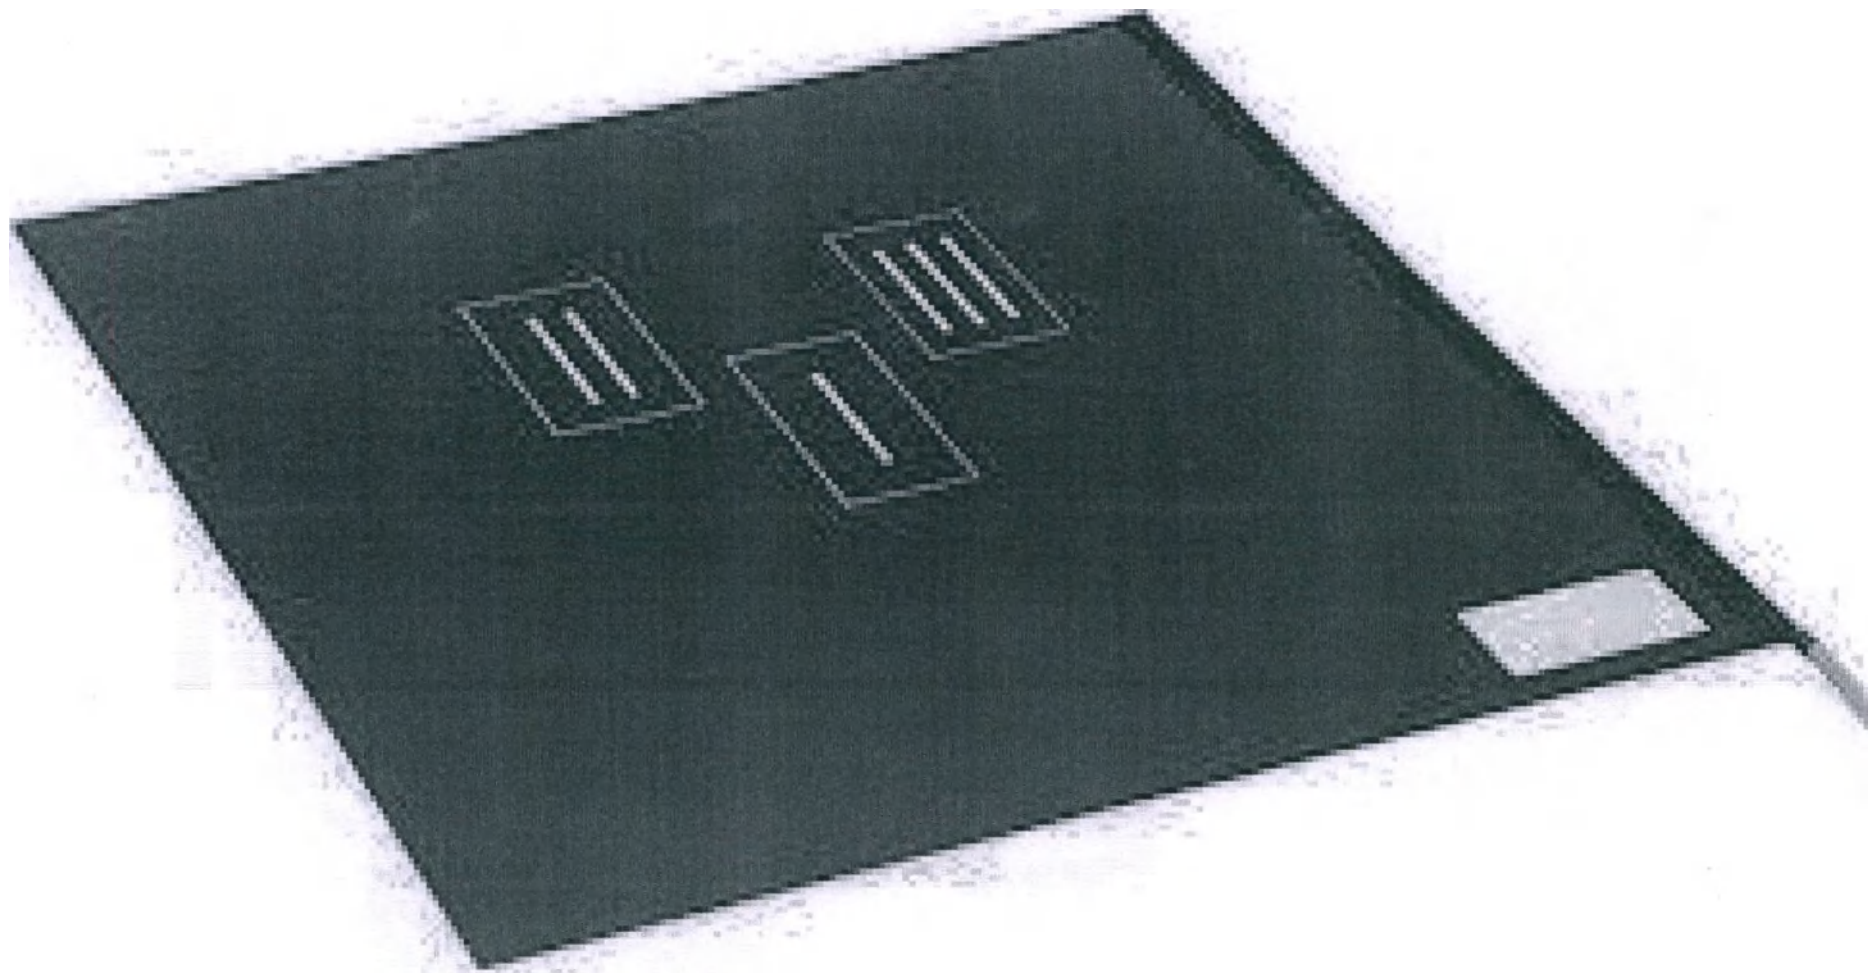

или ХТ; 5FA; 3FA производства Siemens Healthcare GmbH, Германия.

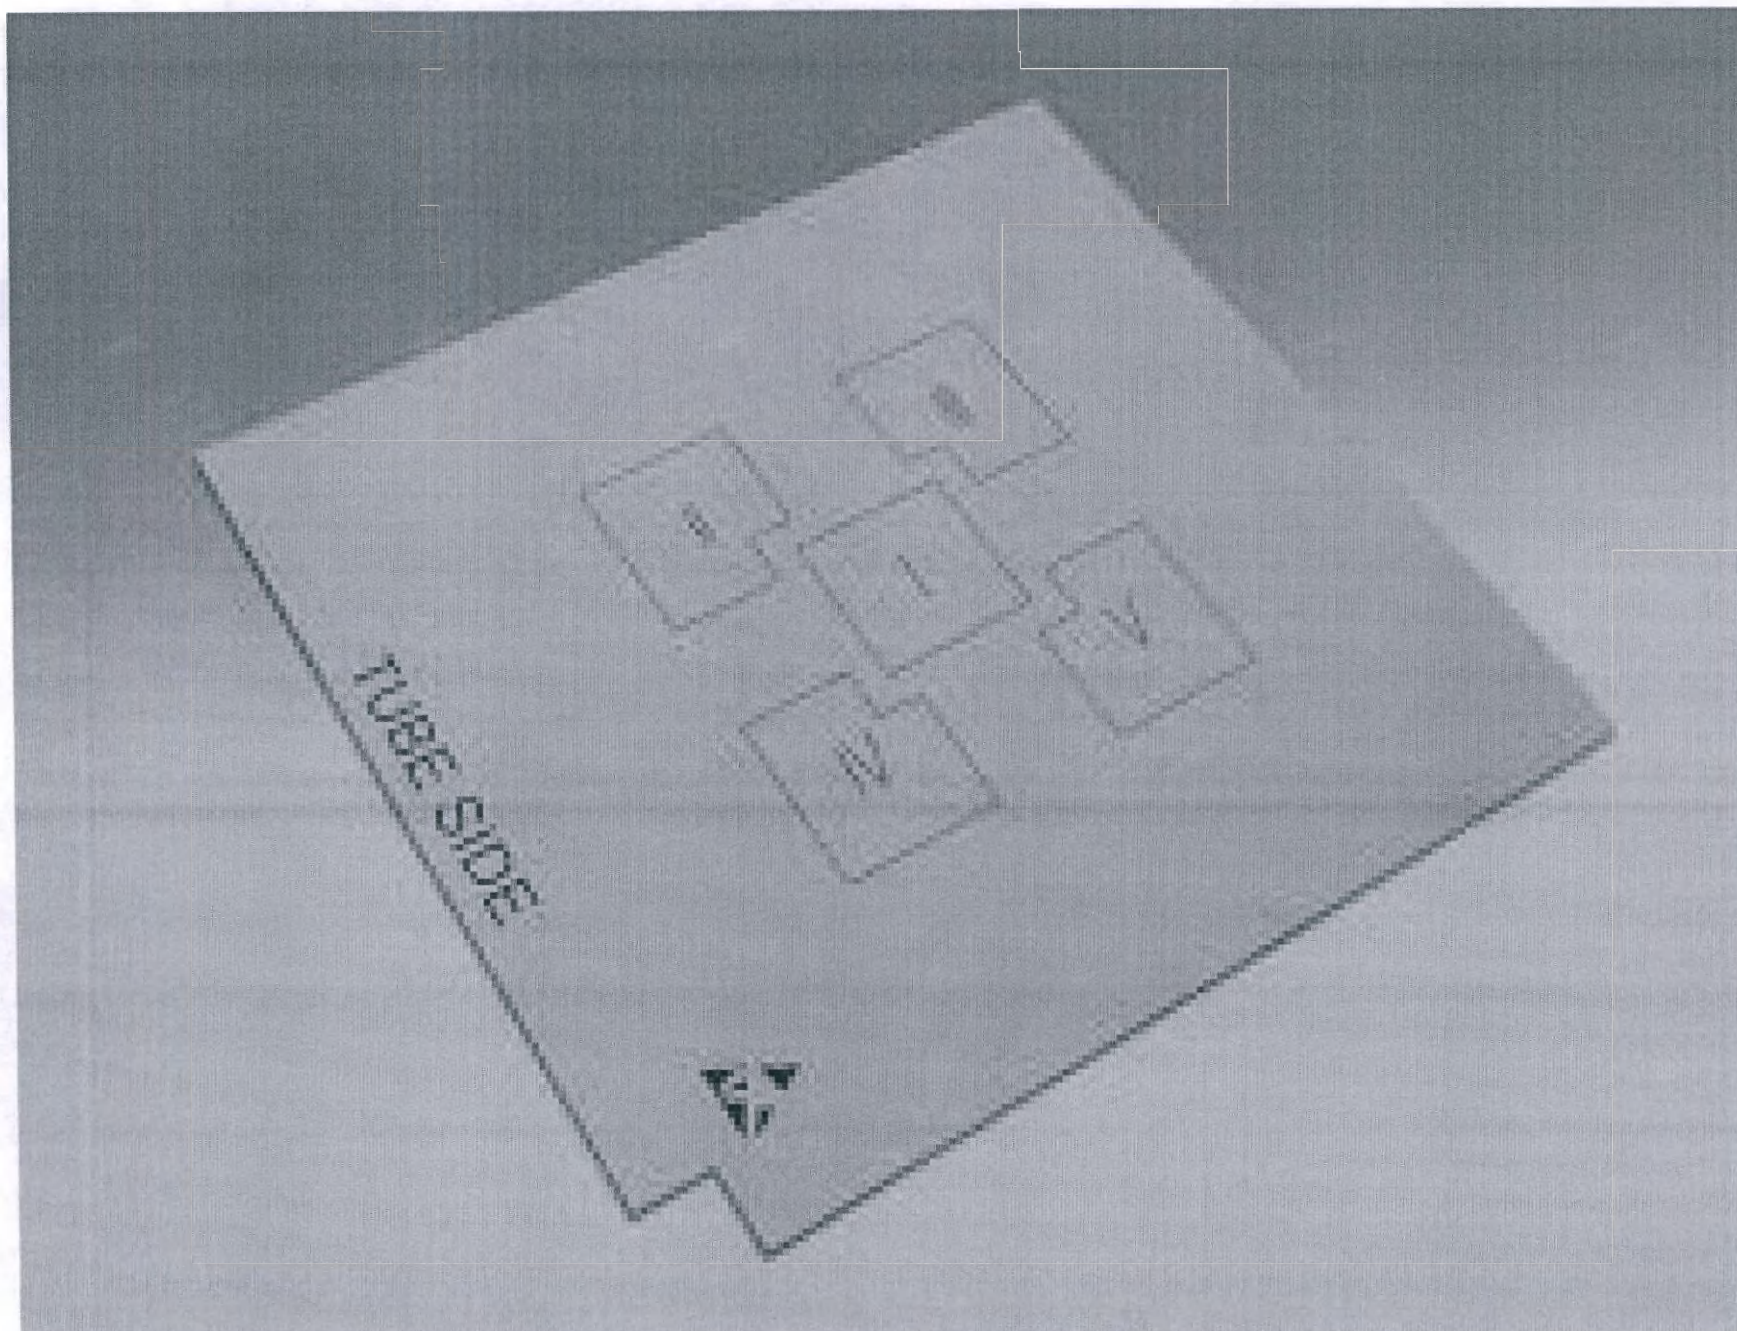


14. Монитор врача CCL; ME; CL; MS; CV; JD производства JVC KENWOOD Corporation, Япония;

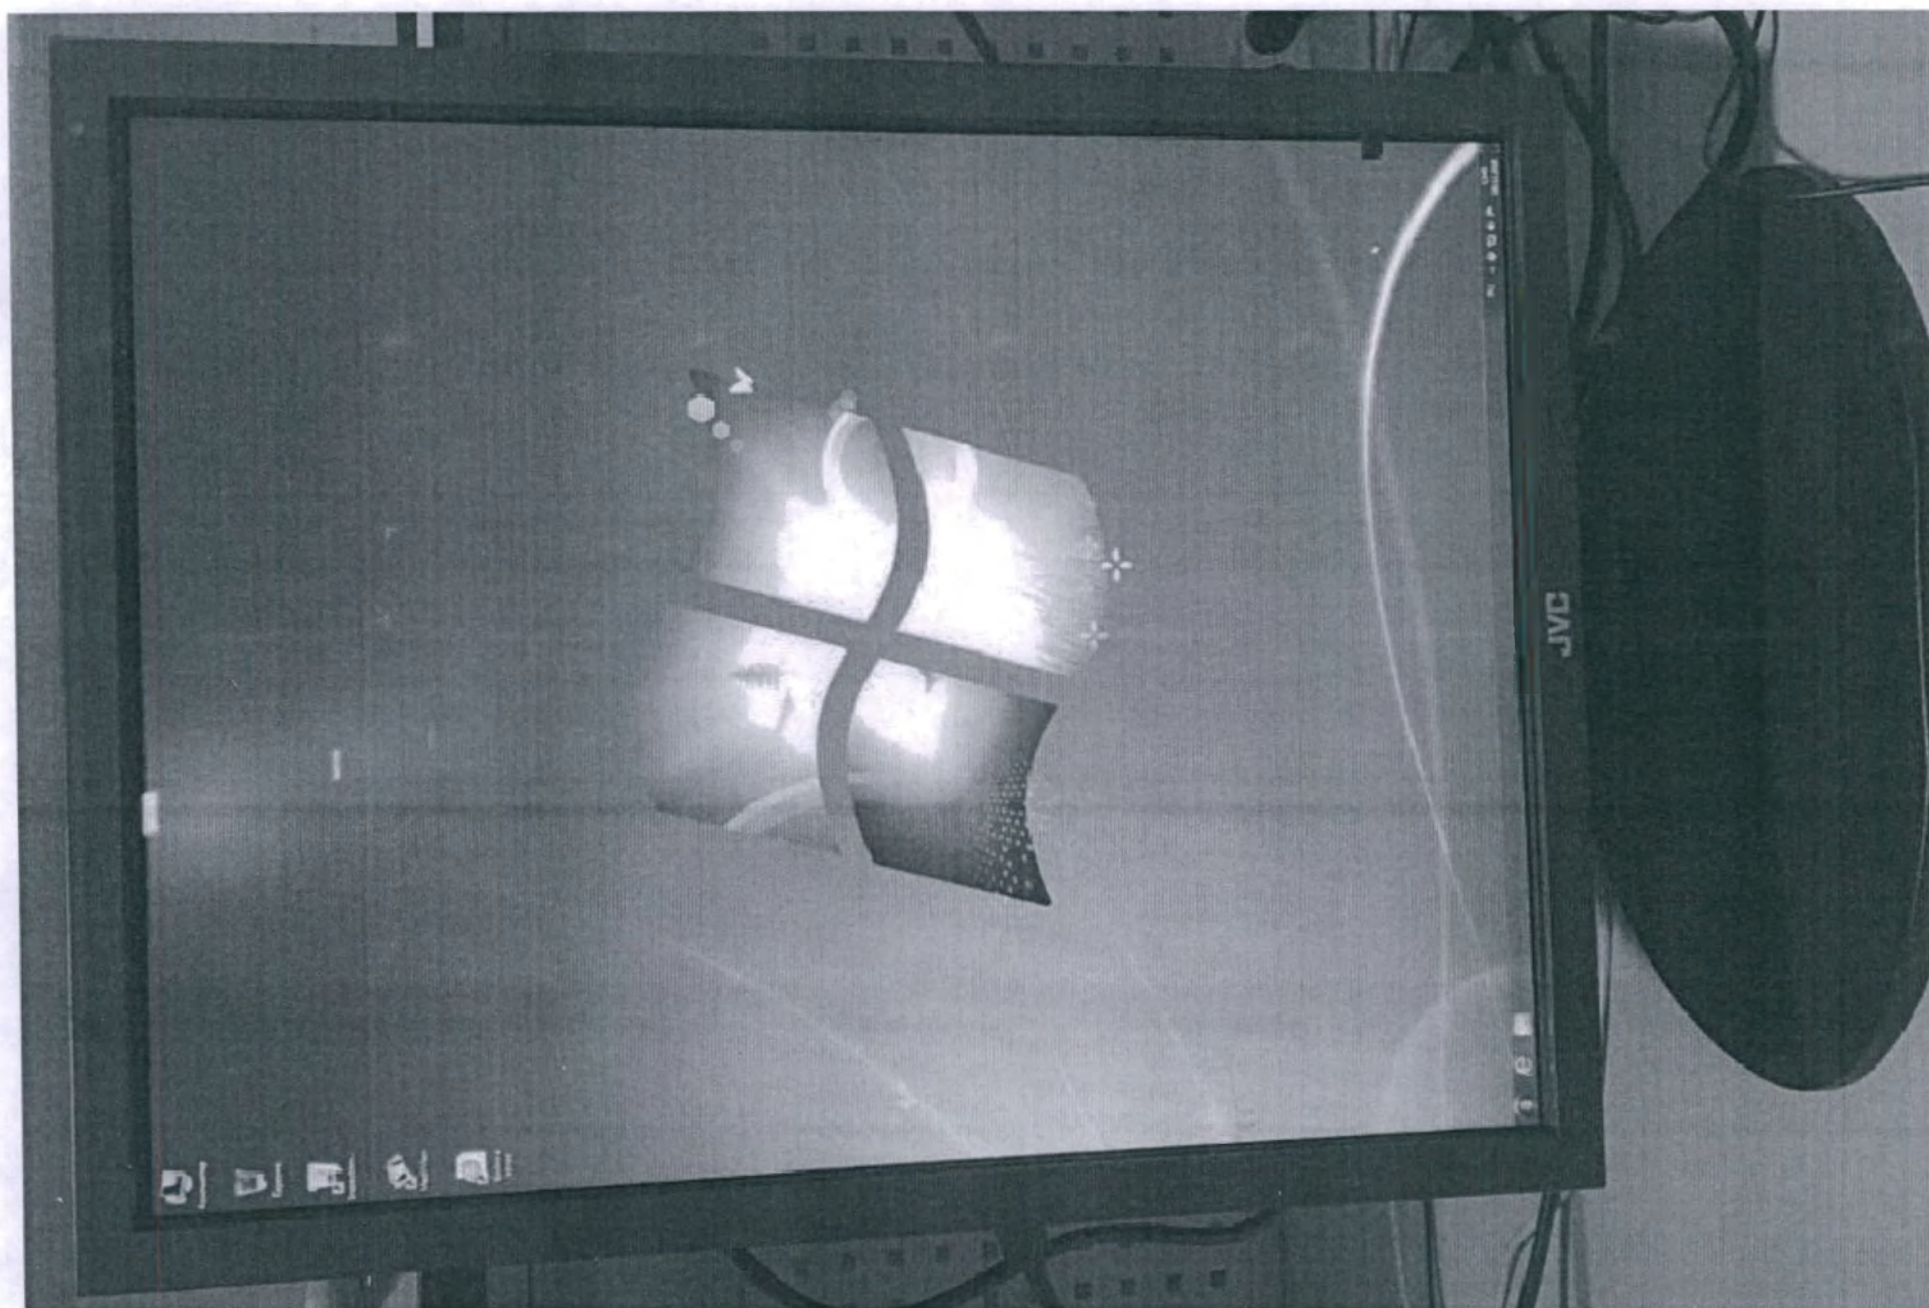

или NDS производства National Display Systems Inc., США;




или NL производства Nical SPA, Италия;

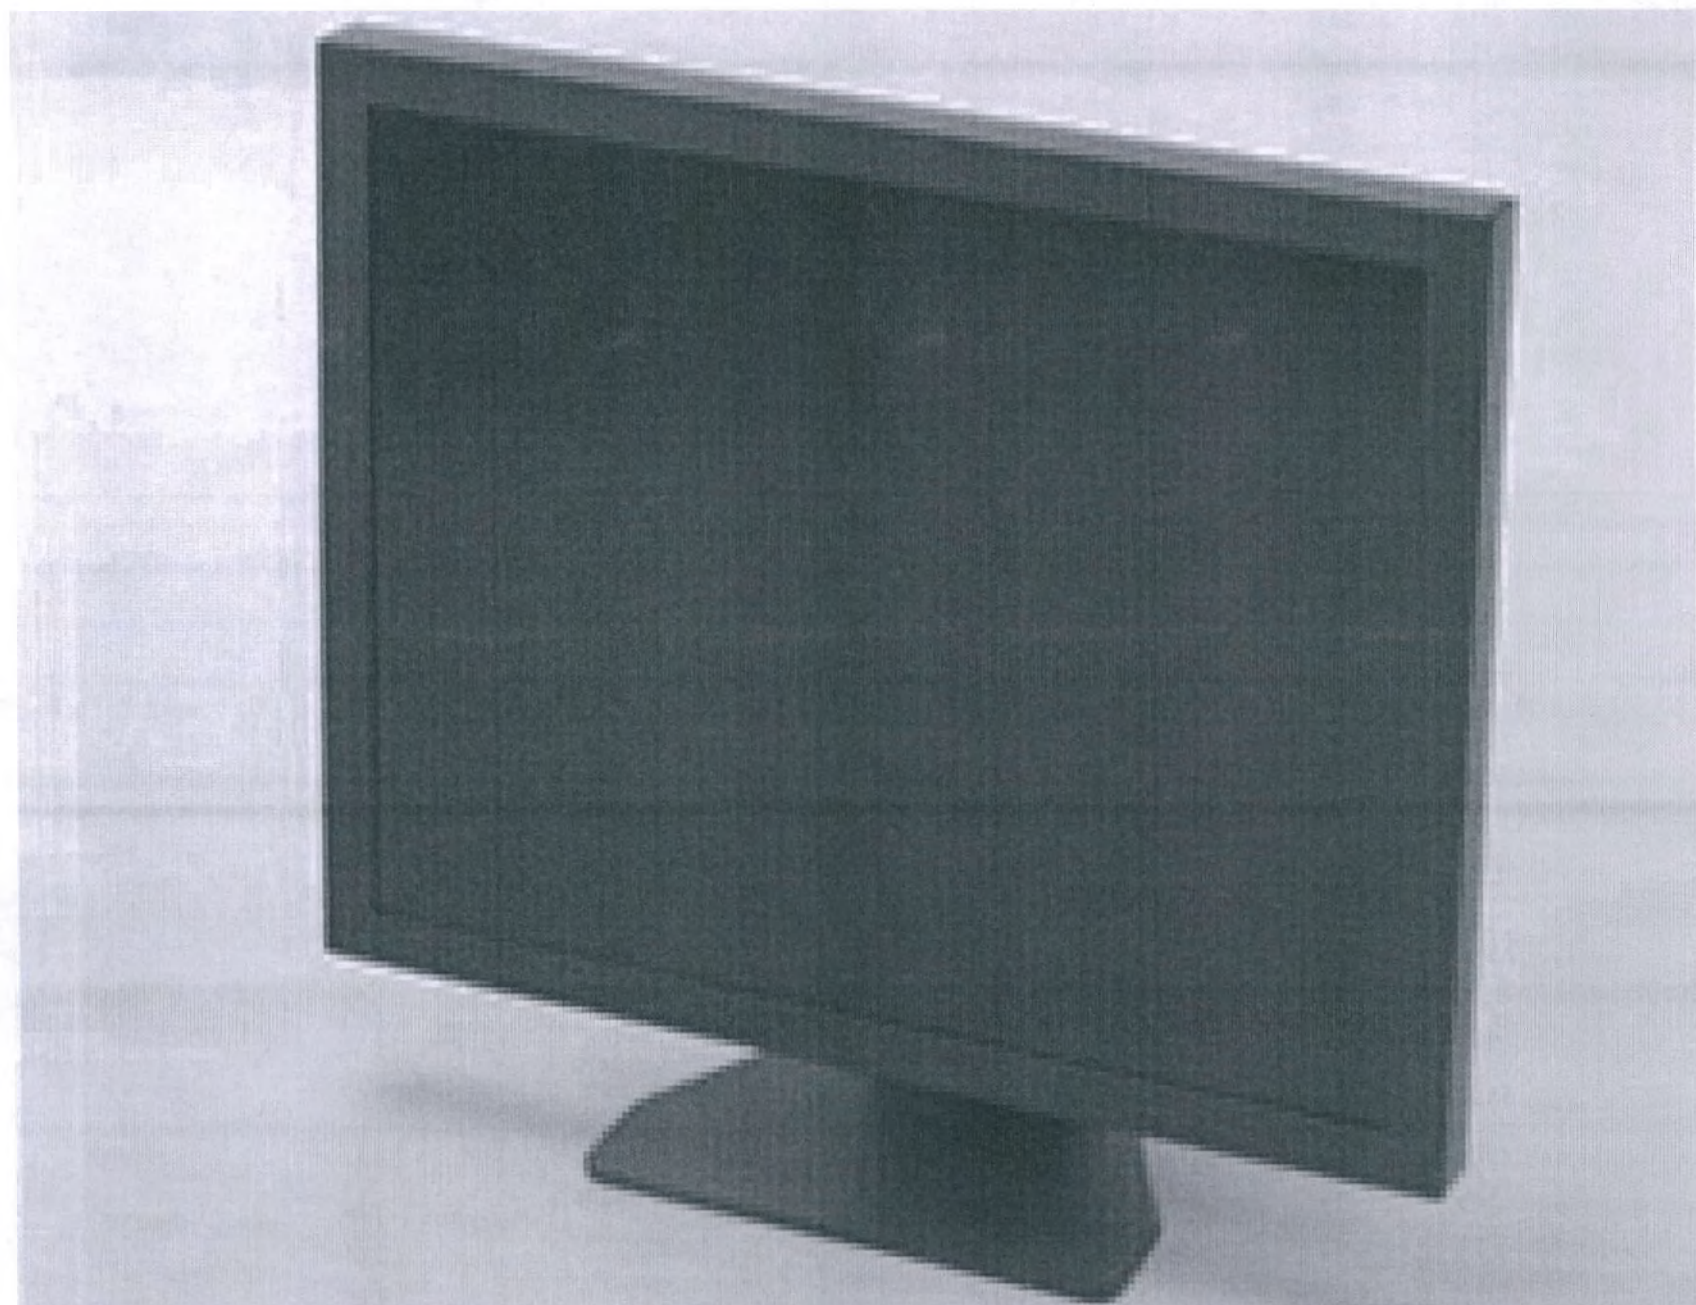

или N, MX, CX, CW производства Wide Corporation, Корея;




или FS; FM; MX производства Foreseeson GmbH, Канада;

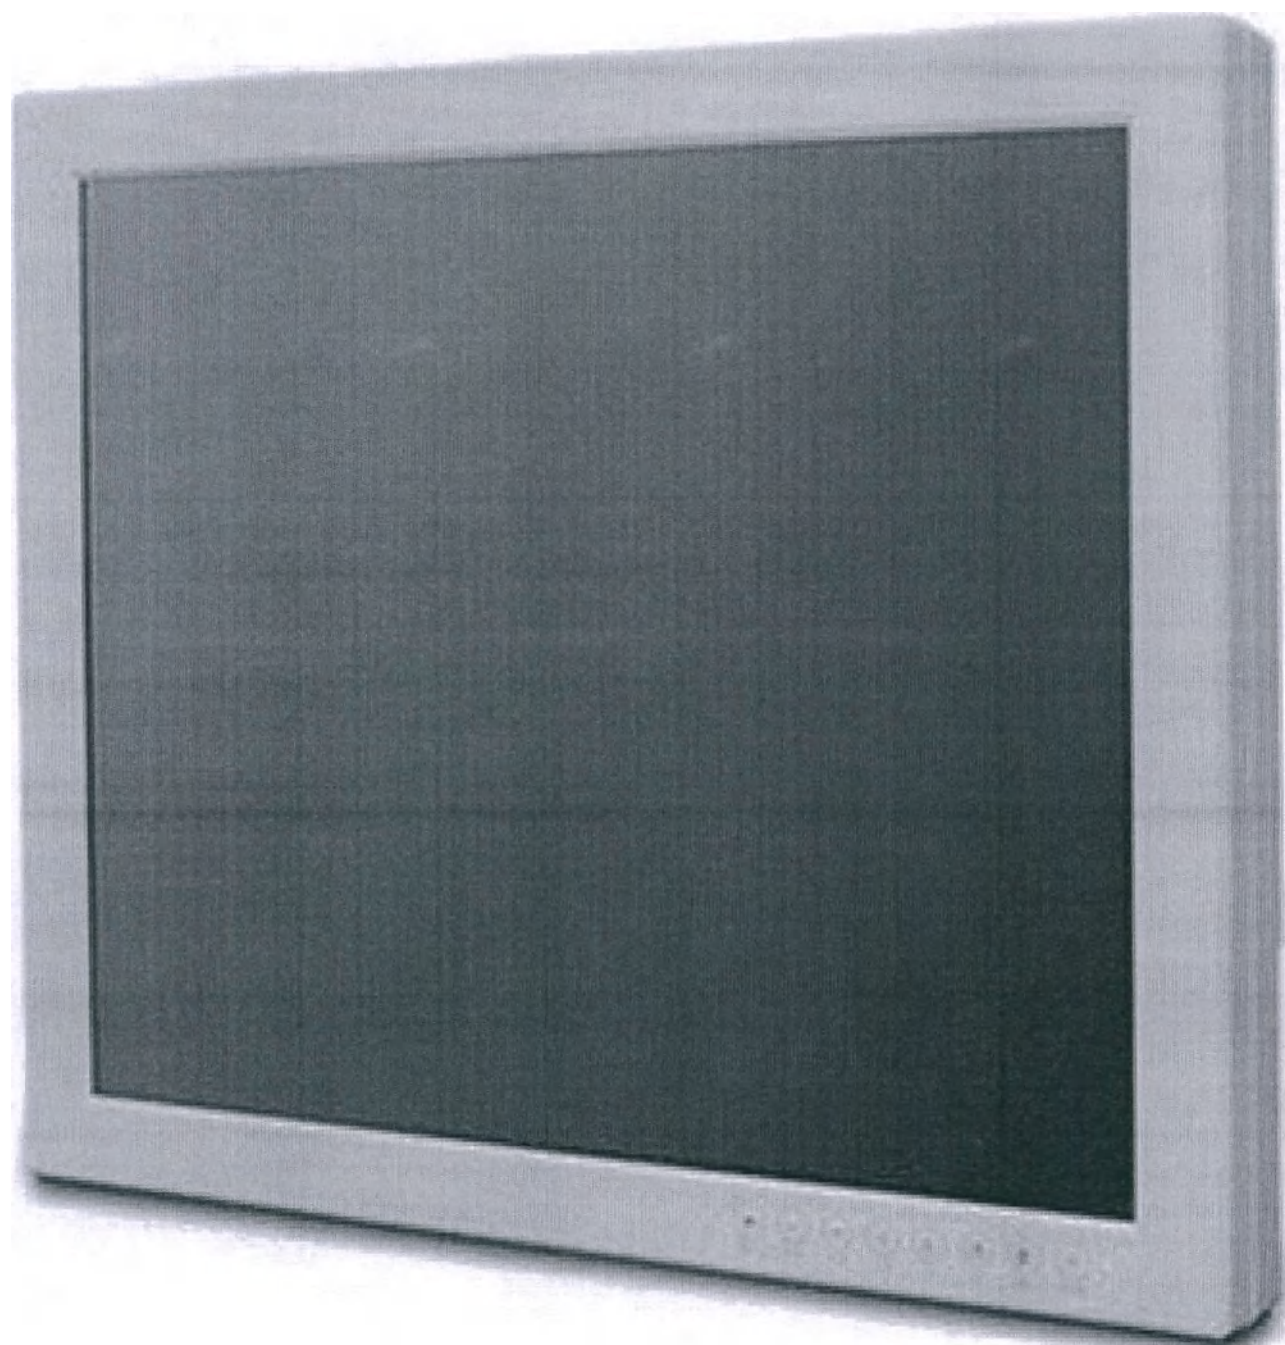


или NEC производства NEC Display Solutions, Япония;




или G, C производства Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай;

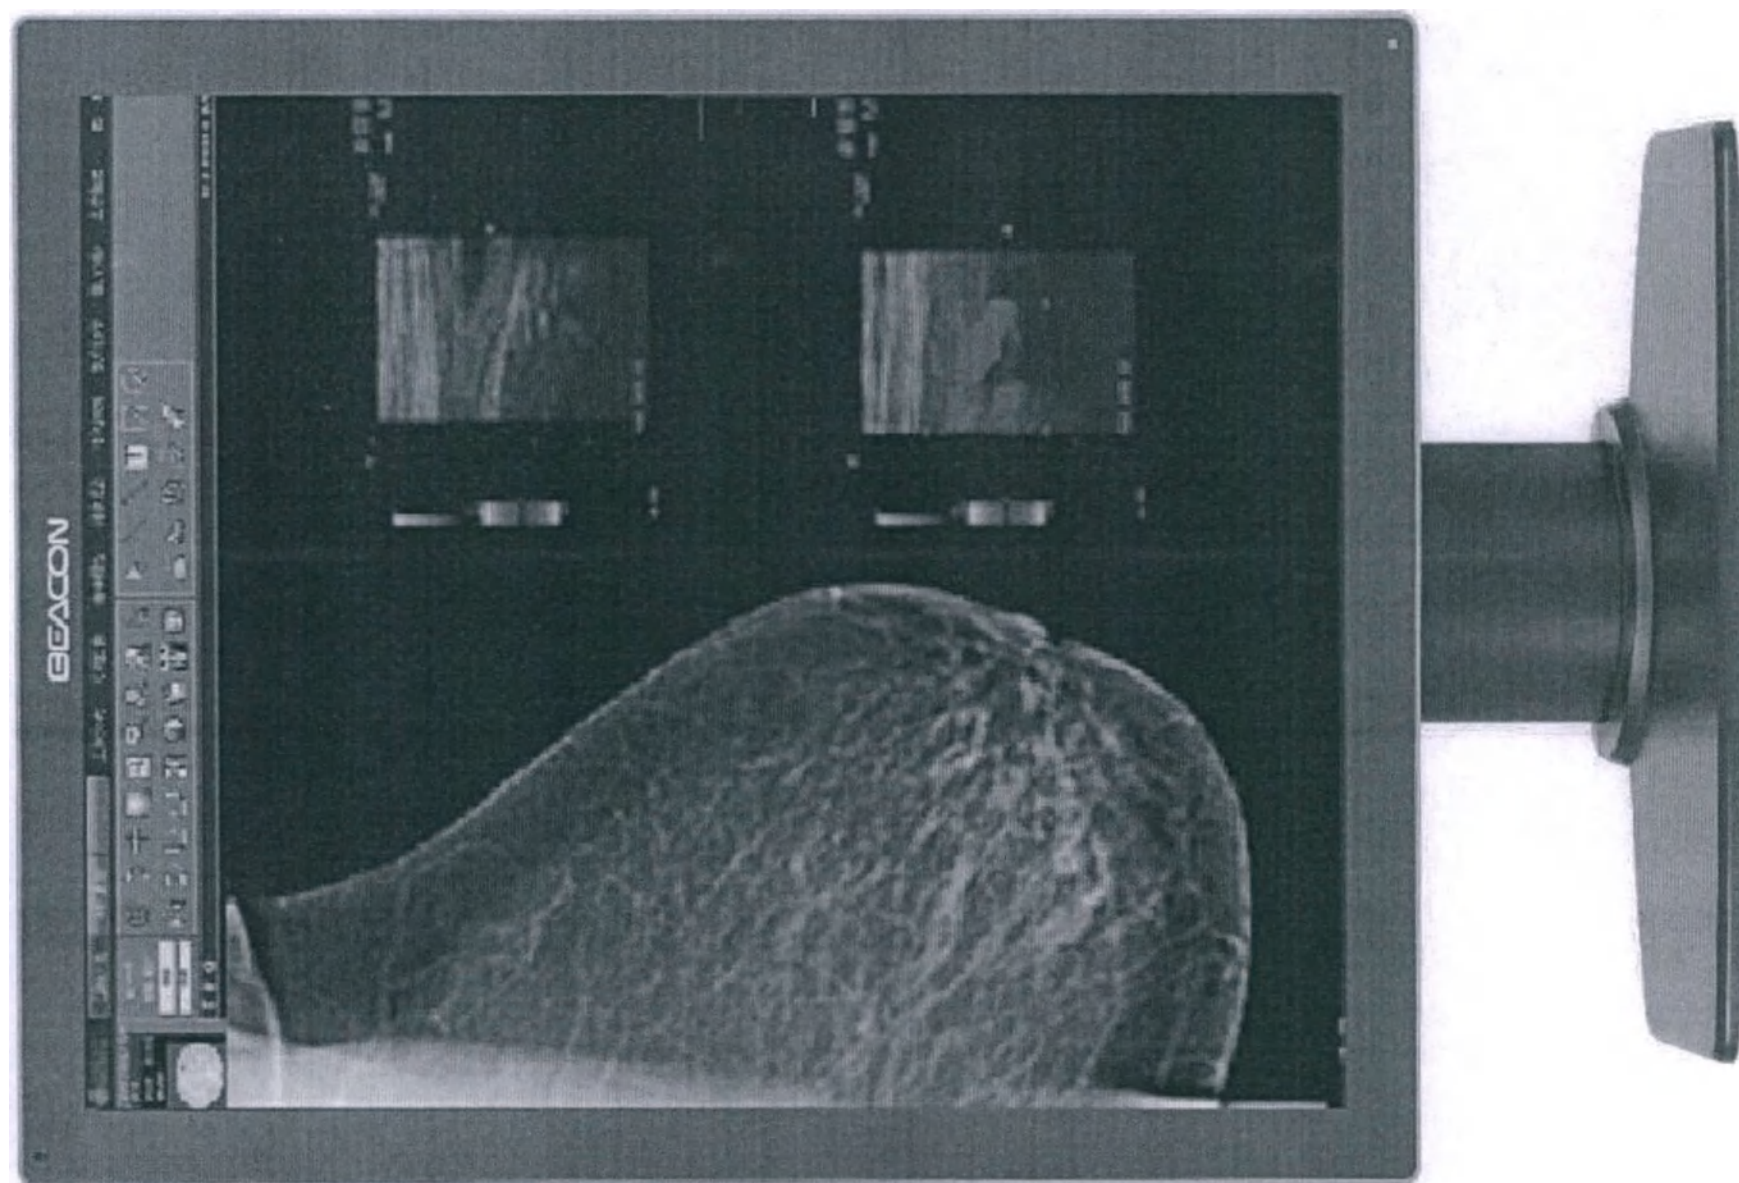


или MD производства BARCO N.V., Бельгия.

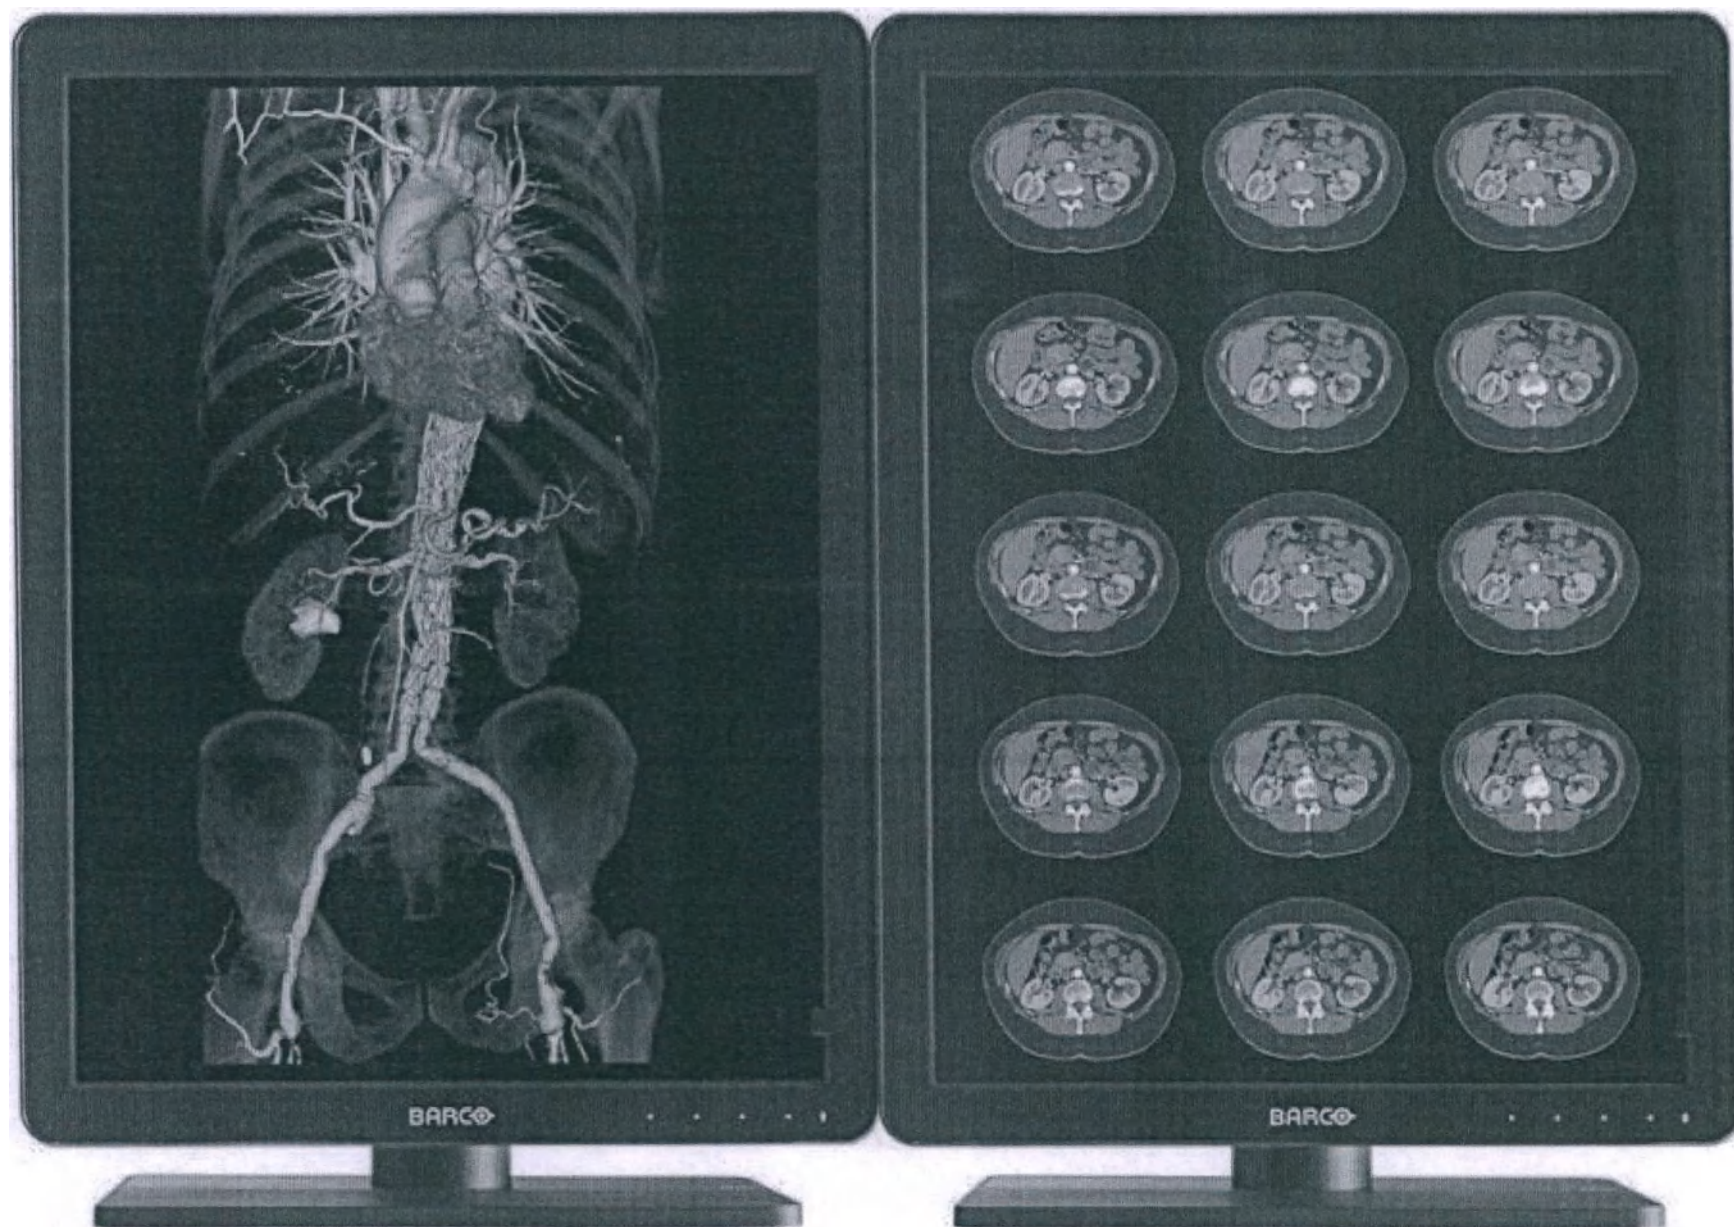

15. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 производства ООО НПП «Доза», Российская Федерация (РУ № РЗН 2014/1562);

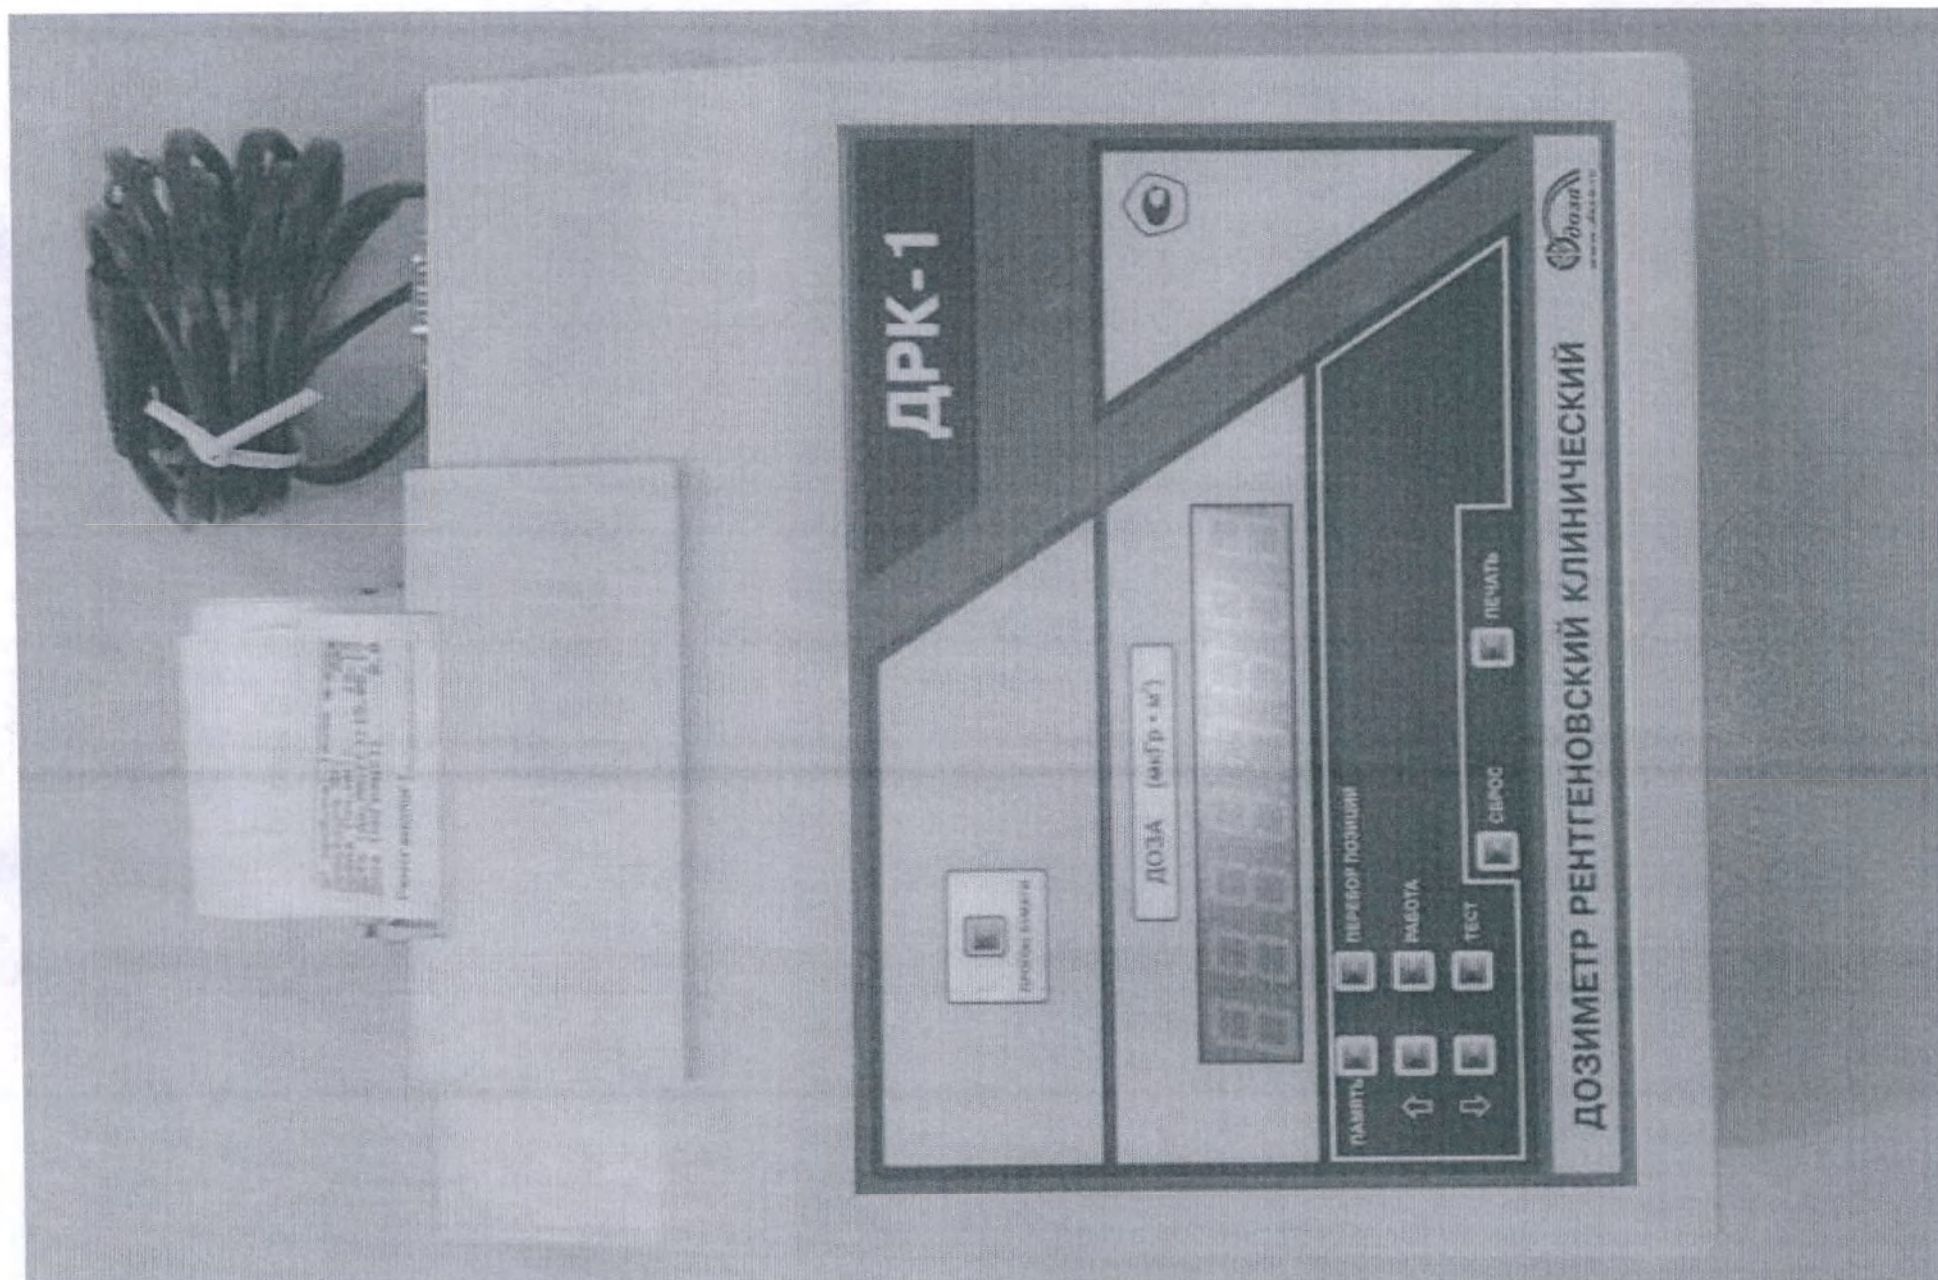


или дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия (РУ № ФСЗ 2012/11816);

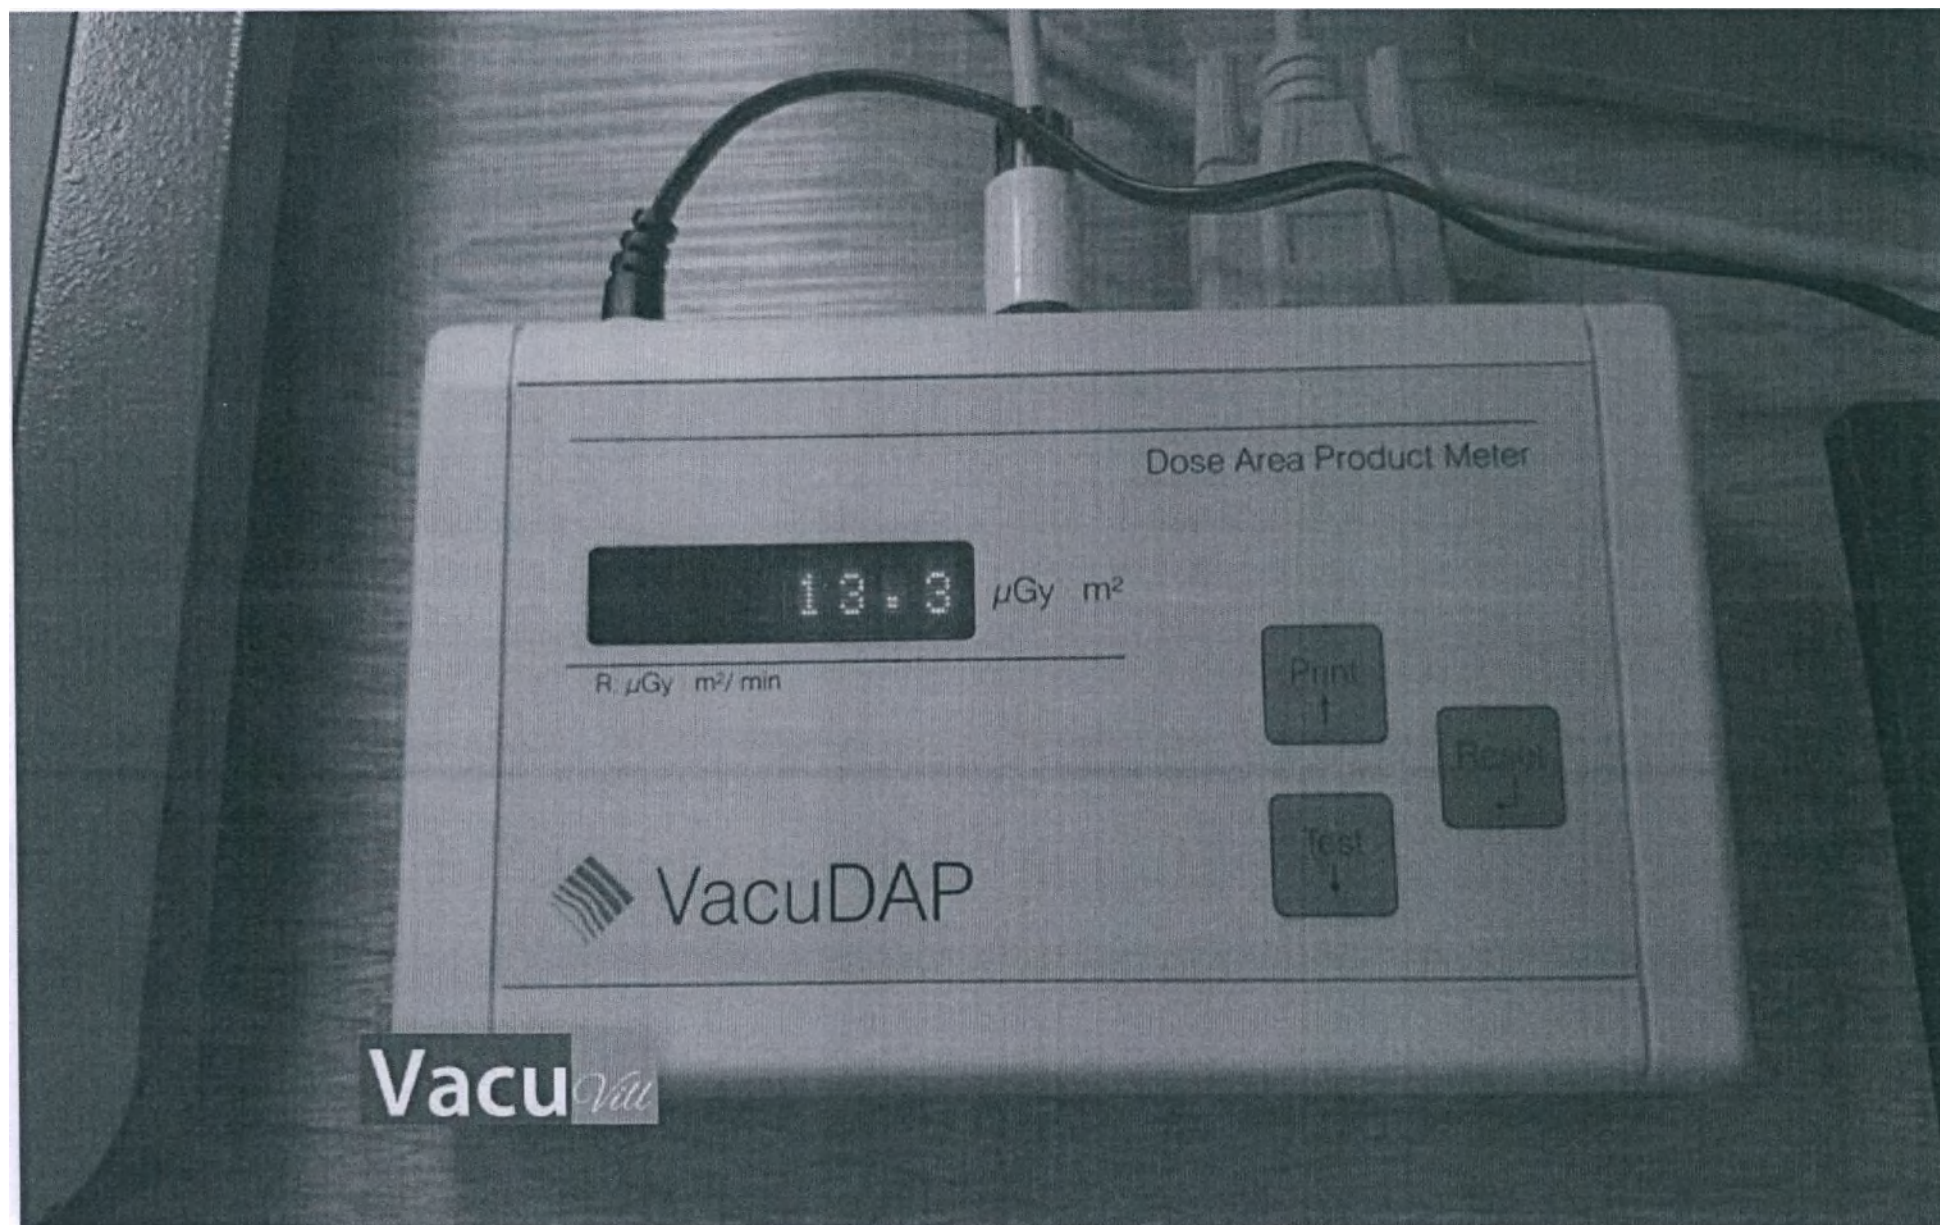


или Кермах производства IBA Dosimetry GmbH, Германия.



16. Комплект кассет, производства ЗАО «Ренекс», Российская Федерация.

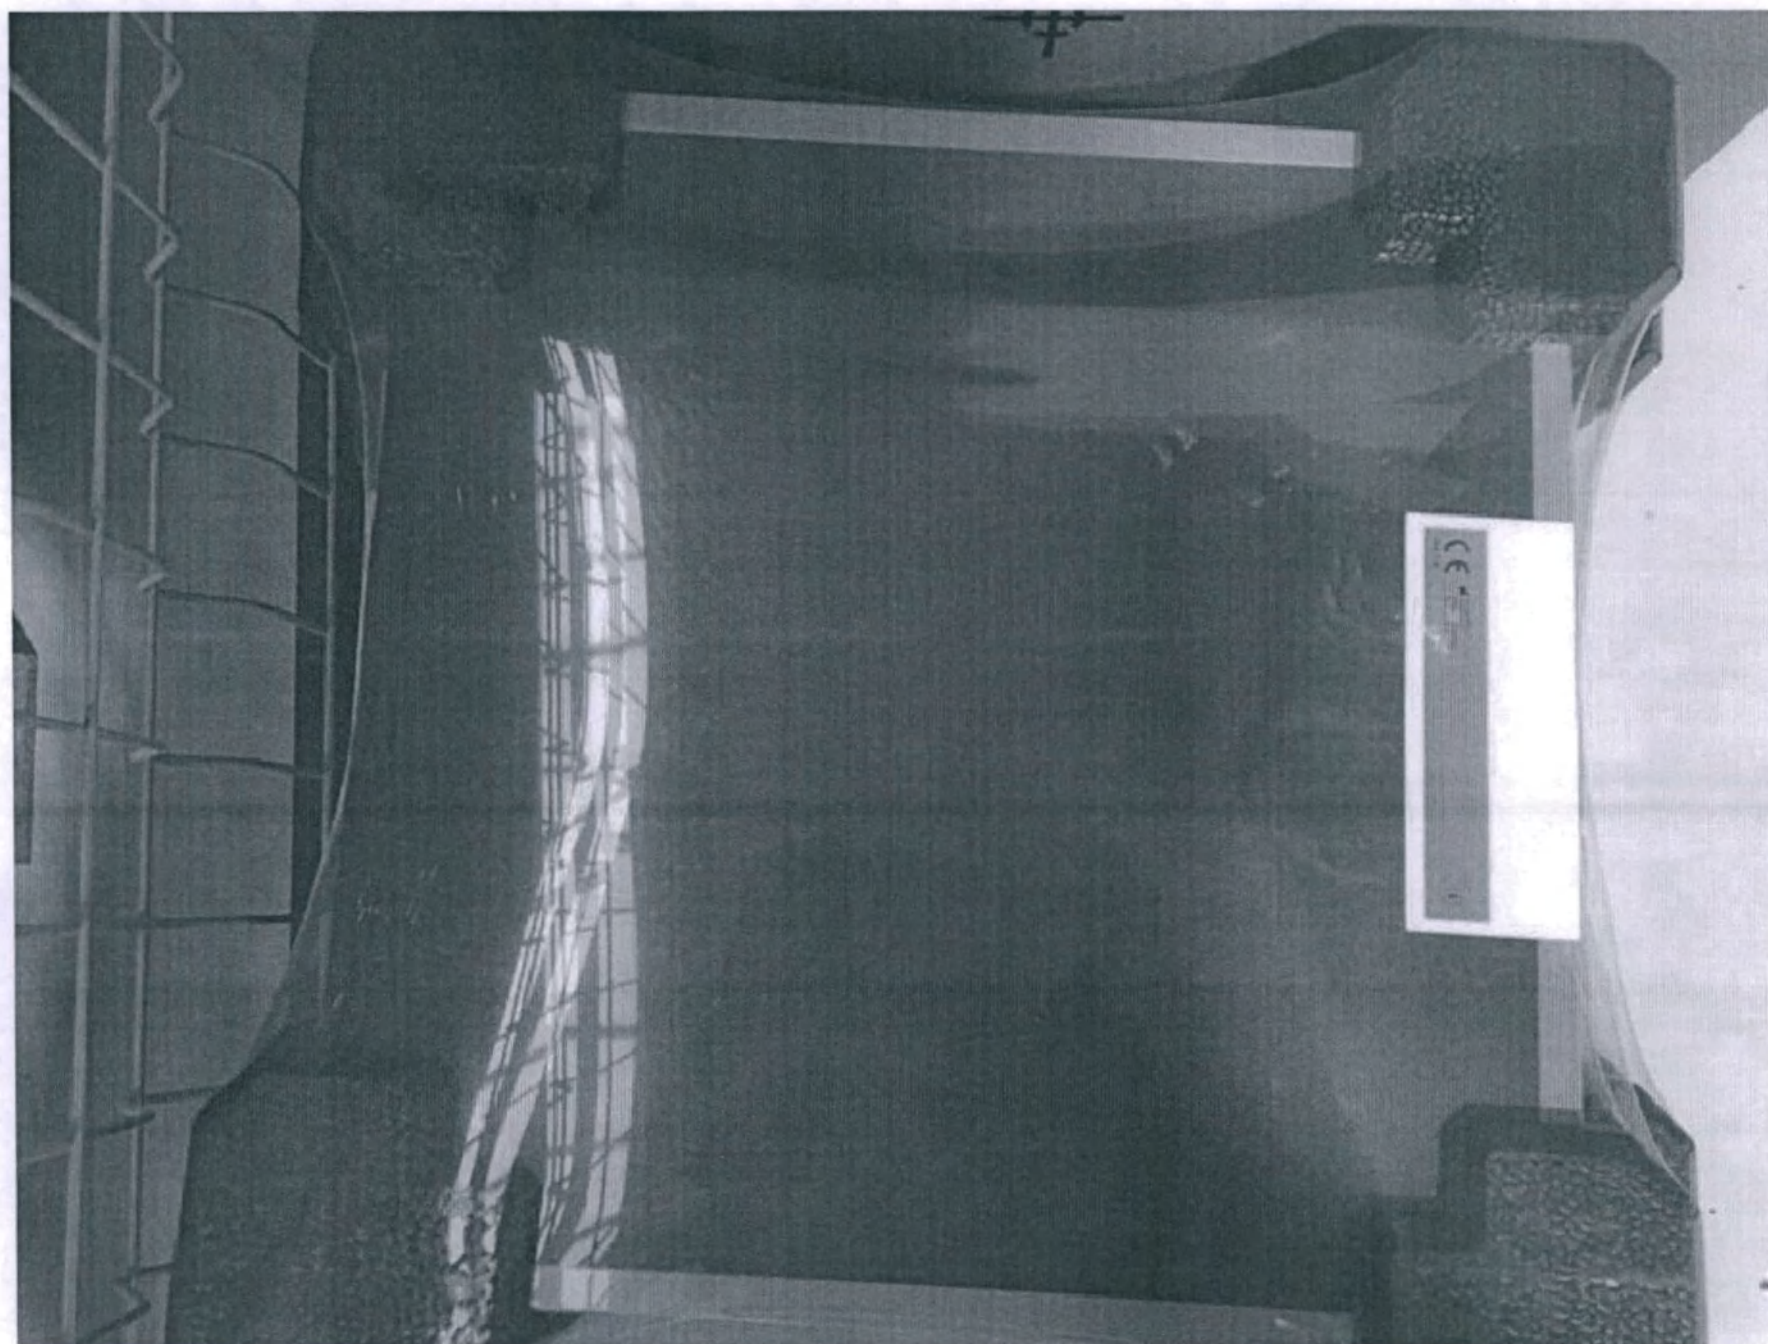


17. Комплекс цифровой CR диагностический для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений (CR 30-Xm или CR 10-X) (ПУ № РЗН 2015/2731) или система компьютерной рентгенографии CR (CR 12-X или CR 15-X) (ПУ № РЗН 2015/3346); или комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений (DX-M или DX-G) (ПУ № ФСЗ 2011/09003) производства Agfa N.V., Бельгия;

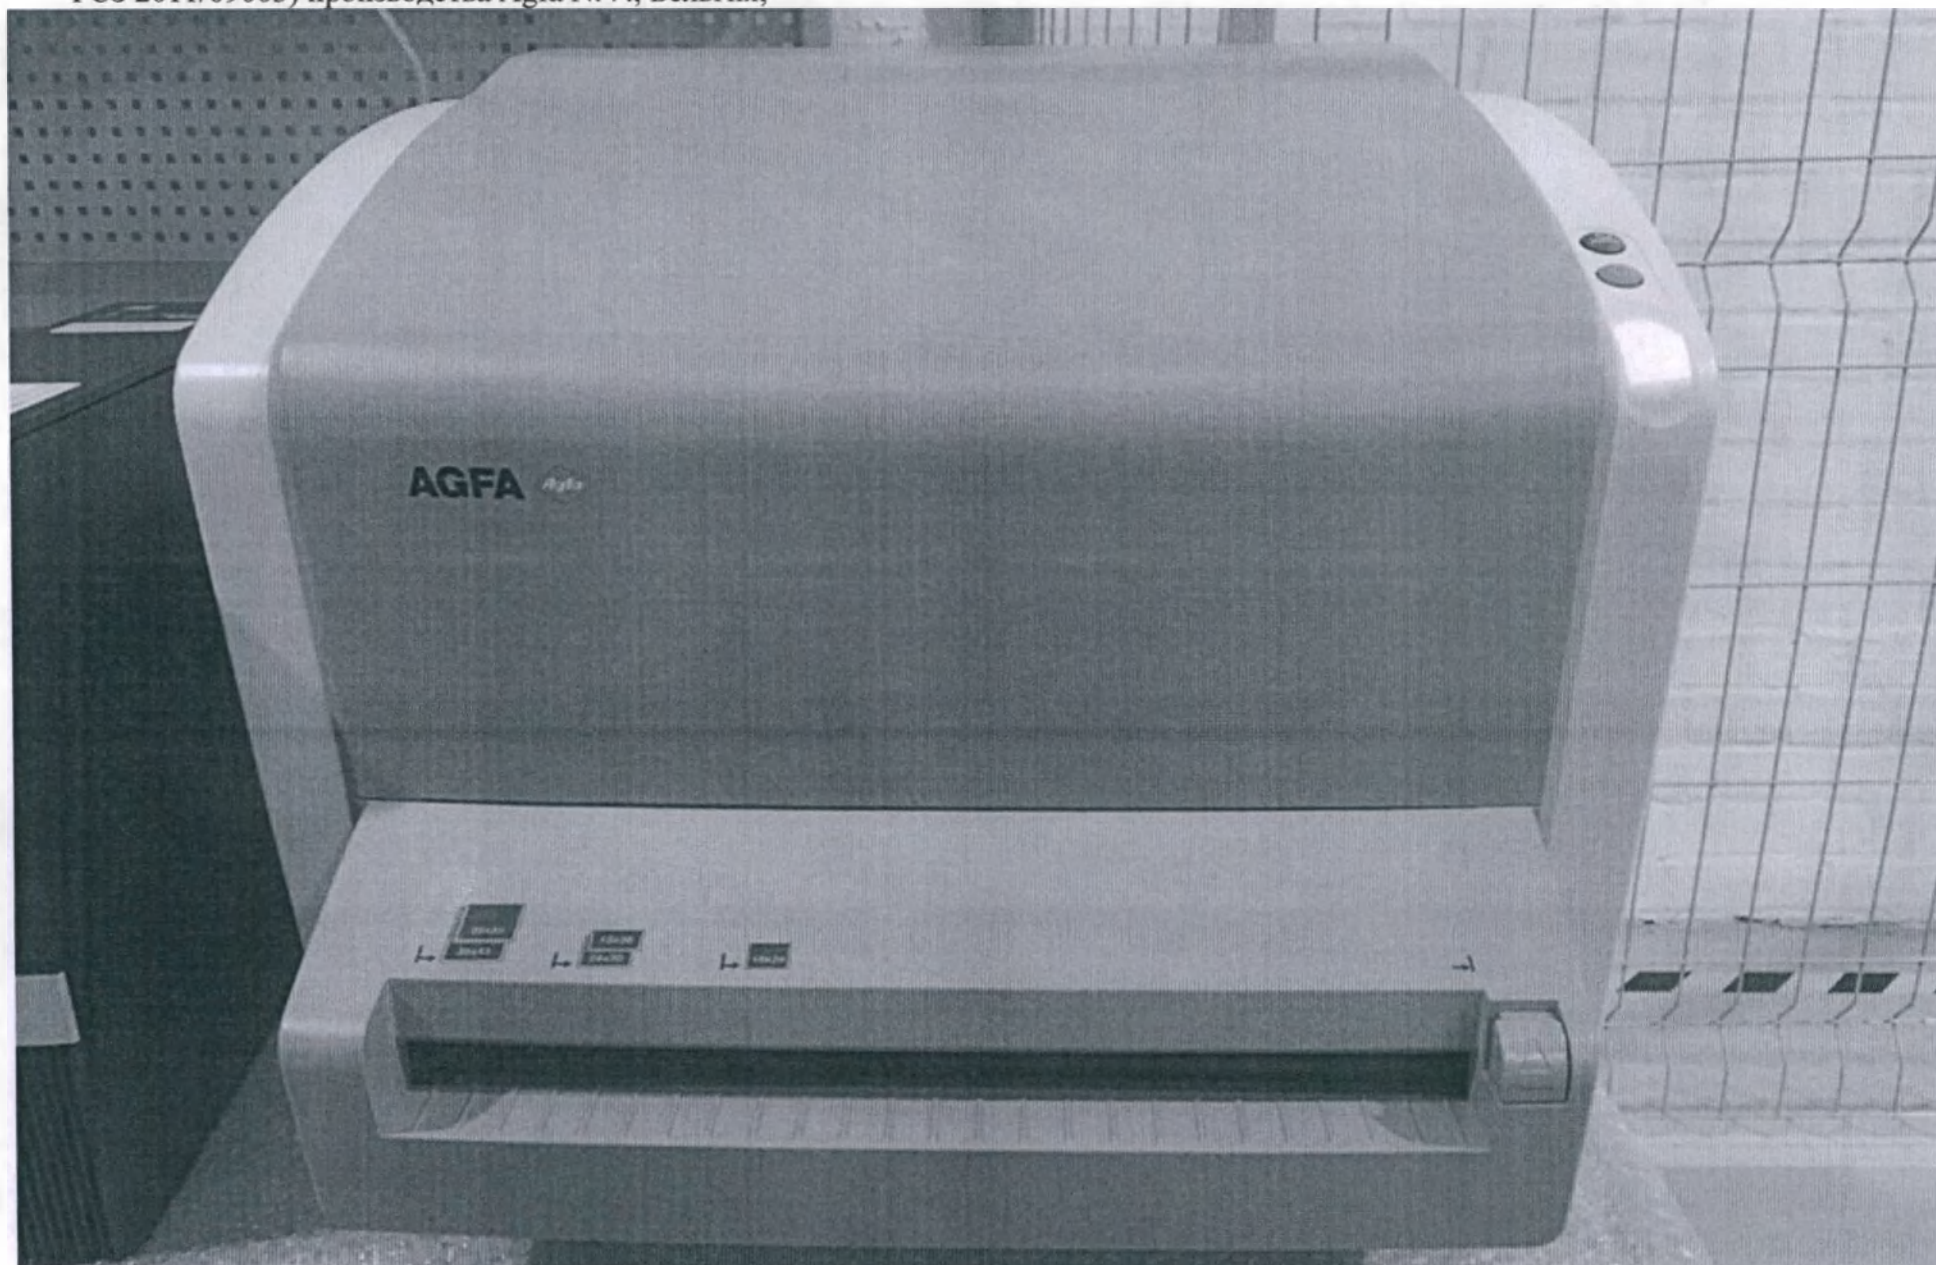

или система компьютерной радиологии REGIUS 110 (ПУ № ФСЗ 2010/06650) или REGIUS 210 (ПУ № ФСЗ 2010/06649) или REGIUS SIGMA (ФСЗ 2011/10738) производства Konica Minolta Medical&Graphic, Inc., Япония;



или система цифровой радиографии Vita Flex CR System (РУ № РЗН 2017/5376) или Vita XE или серии CR System исполнения: Classic, Elite (РУ № ФСЗ 2010/08204) производства Carestream Health Inc., США;

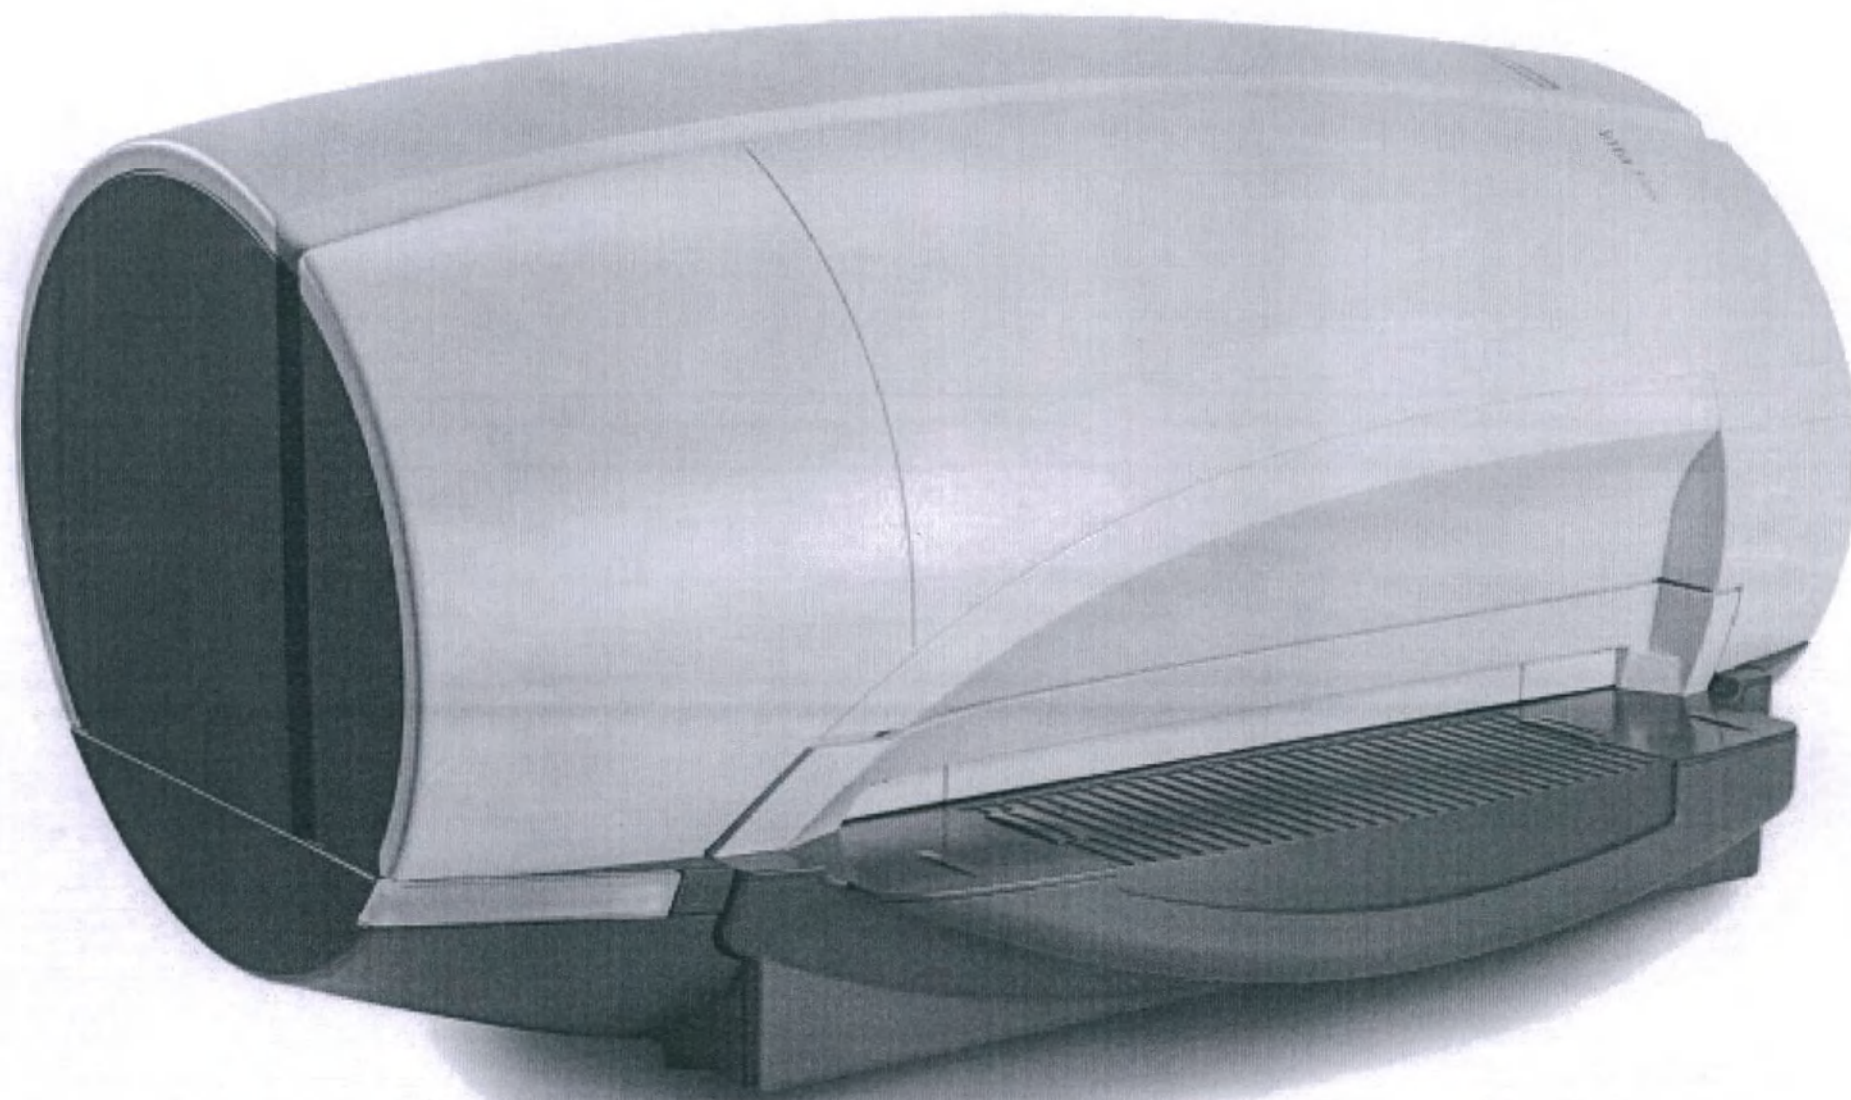

или Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров, модели: FCR Capsula X (CR-IR 357), FCR Capsula XL (CR-IR 356), FCR Profect One (CR-IR 368), FCR XG1 (CR-IR 346), FCR XG5000 (CR-IR 362), FCR Profect CS (CR-IR 363) (ПУ № ФСЗ 2007/00091) или FCR Prima T (CR-IR 392) (ПУ № РЗН 2013/910) или устройство для цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров FCR Capsula XL2 (CR-IR 359) (ПУ № ФСЗ 2009/04740) или FCR PROPECT CS Plus производства Fujifilm Corporation, Япония;




или CR 3600 или CR Chrome производства iCRco Inc., США;




или аппарат компьютерной радиологии FireCR Spark производства 3D Imaging & Simulations Corp. (3DISC), США (ПУ № РЗН 2018/7751).



18. АРМ врача-рентгенолога производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

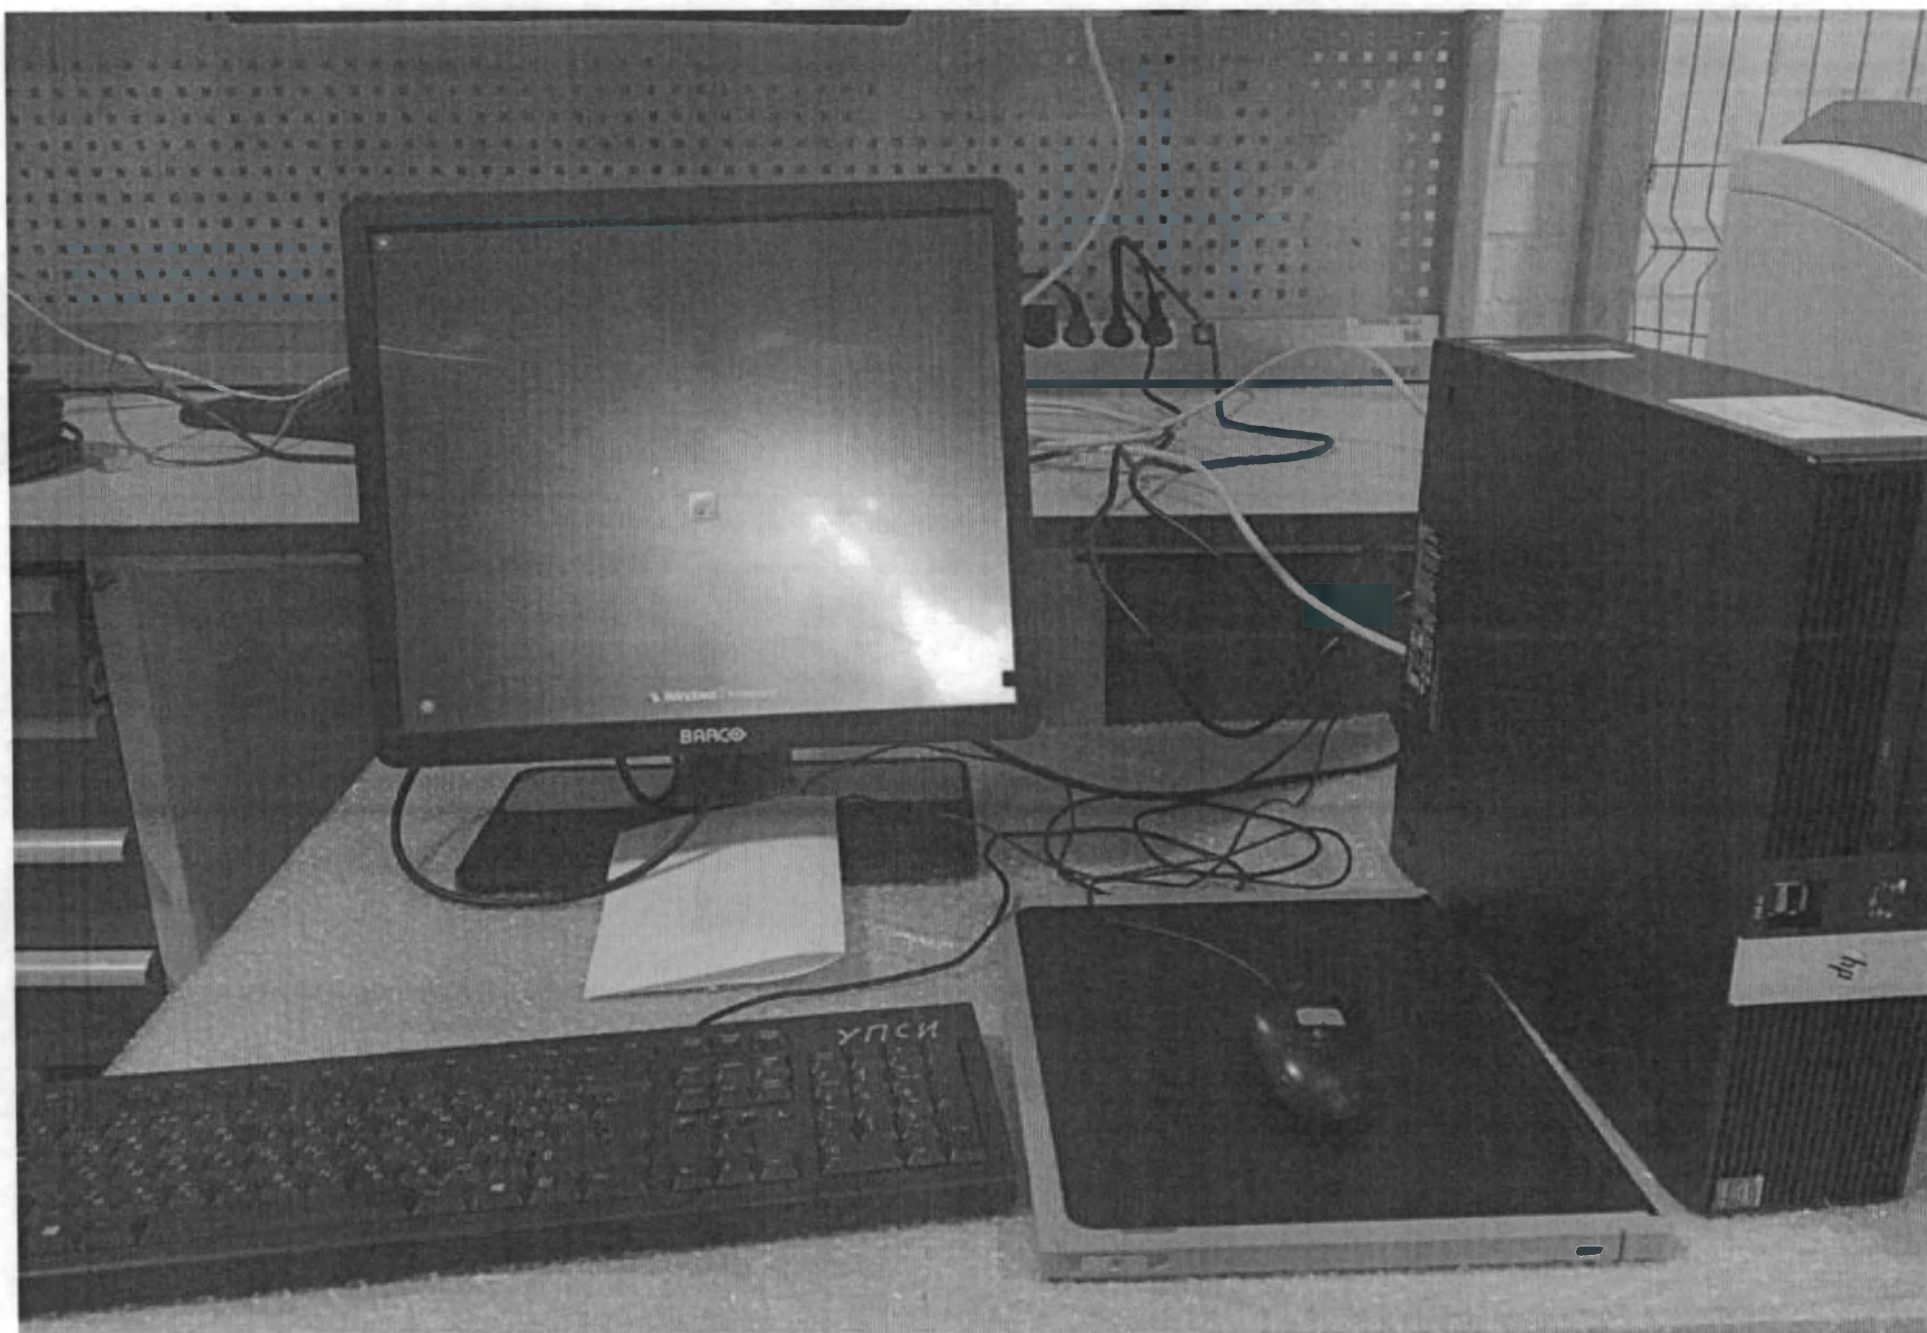

или комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007 производства ООО «МЕД-РЕЙ», Россия (РУ № ФСР 2008/02715).

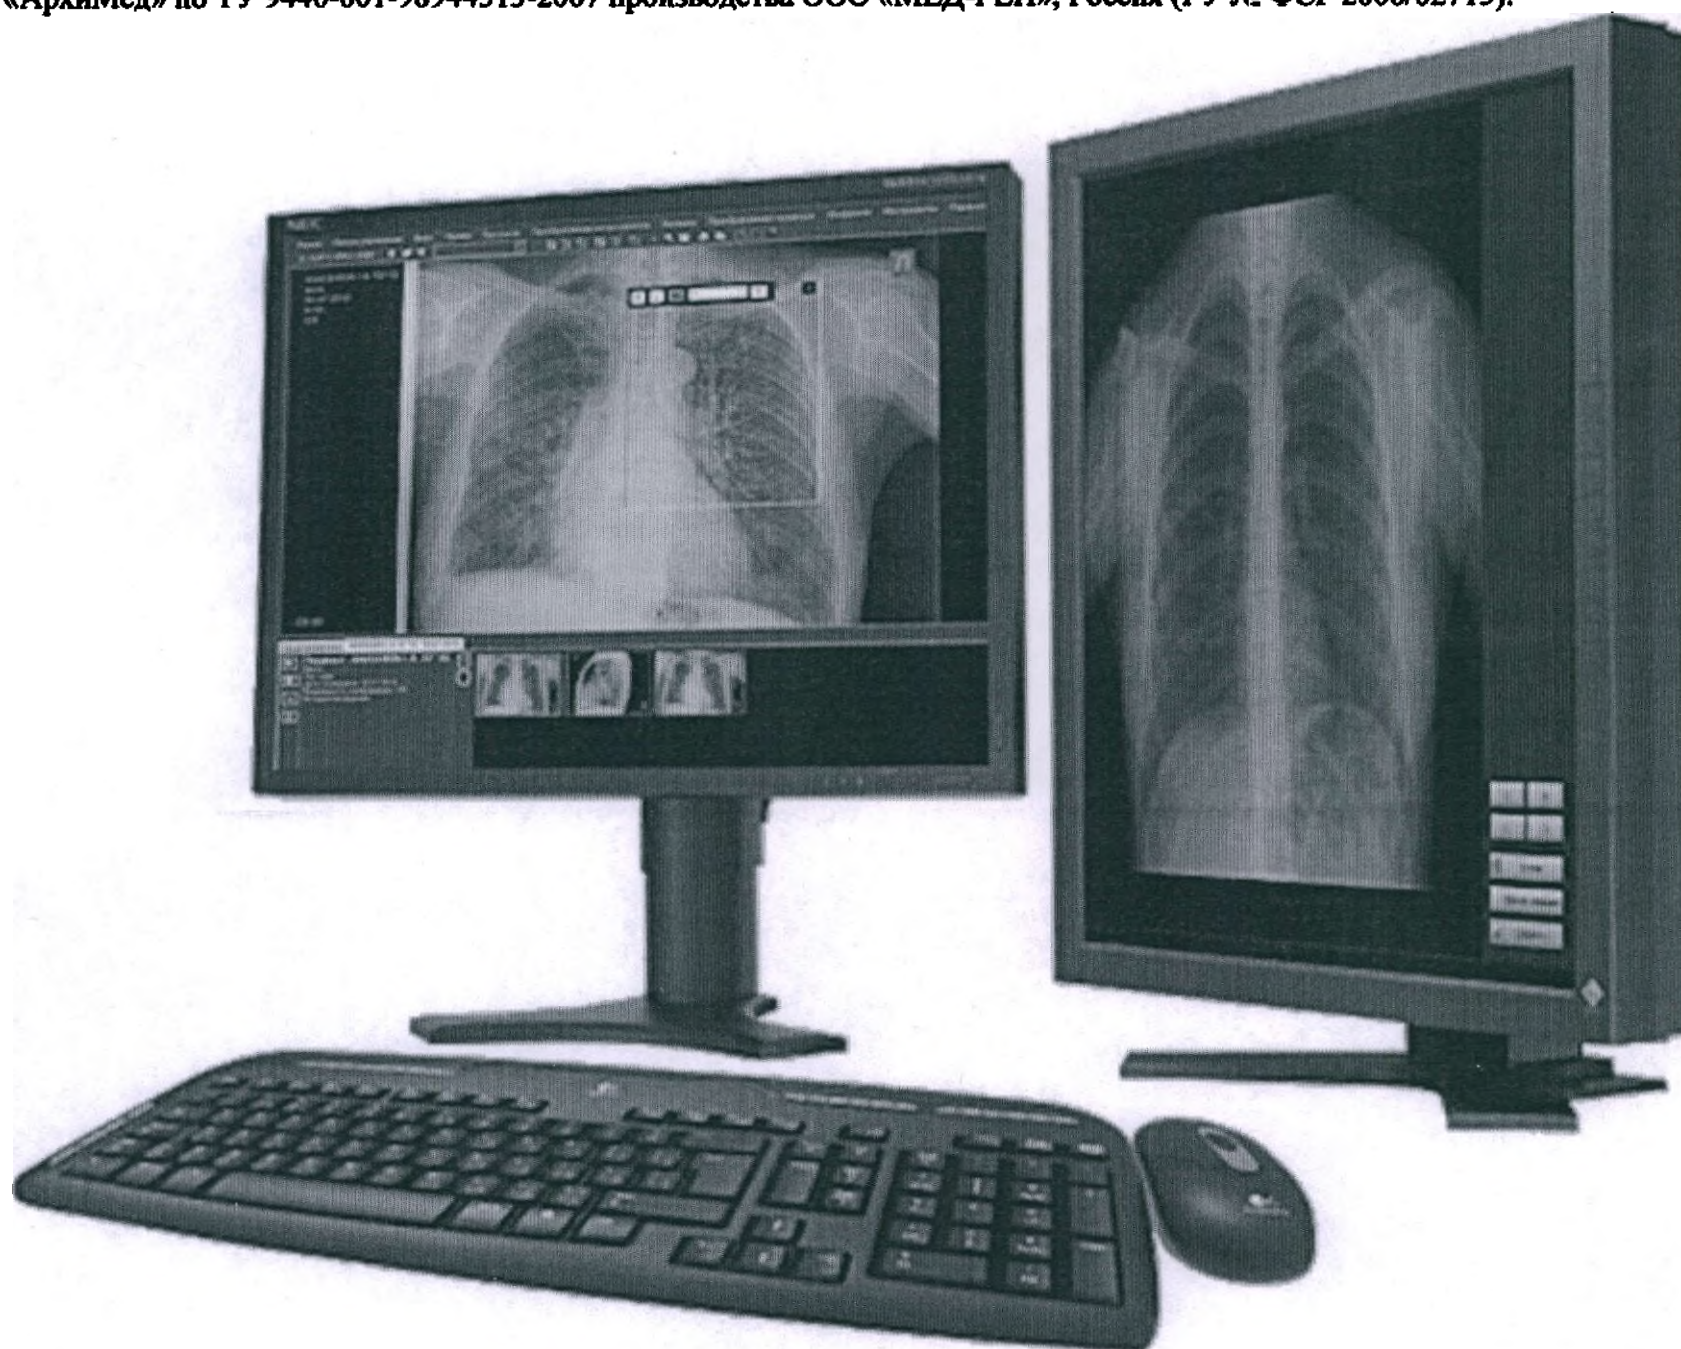

19. Камера мультиматная термографическая Drystar Axys или Drystar 5302 (ПУ № ФСЗ 2008/02792) или Drystar 5503 производства Agfa N.V., Бельгия;




или камера медицинская термографическая мультиформатная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite (ПУ № РЗН 2013/911) или камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX 4000 исполнения DRYPIX Plus (ПУ № ФСЗ 2012/12949) производства Fujifilm Corporation, Япония;



или камера лазерная мультиформатная TRIMAX TX55 Laser Imaging System (ПУ № РЗН 2016/4667) или камера лазерная мультиформатная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений (ПУ № ФСЗ 2011/10352) производства Carestream Health, Inc., США;



или устройство для печати монохромных медицинских изображений UP производства Sony Corporation, Япония (РУ ФСЗ 2011/10354).

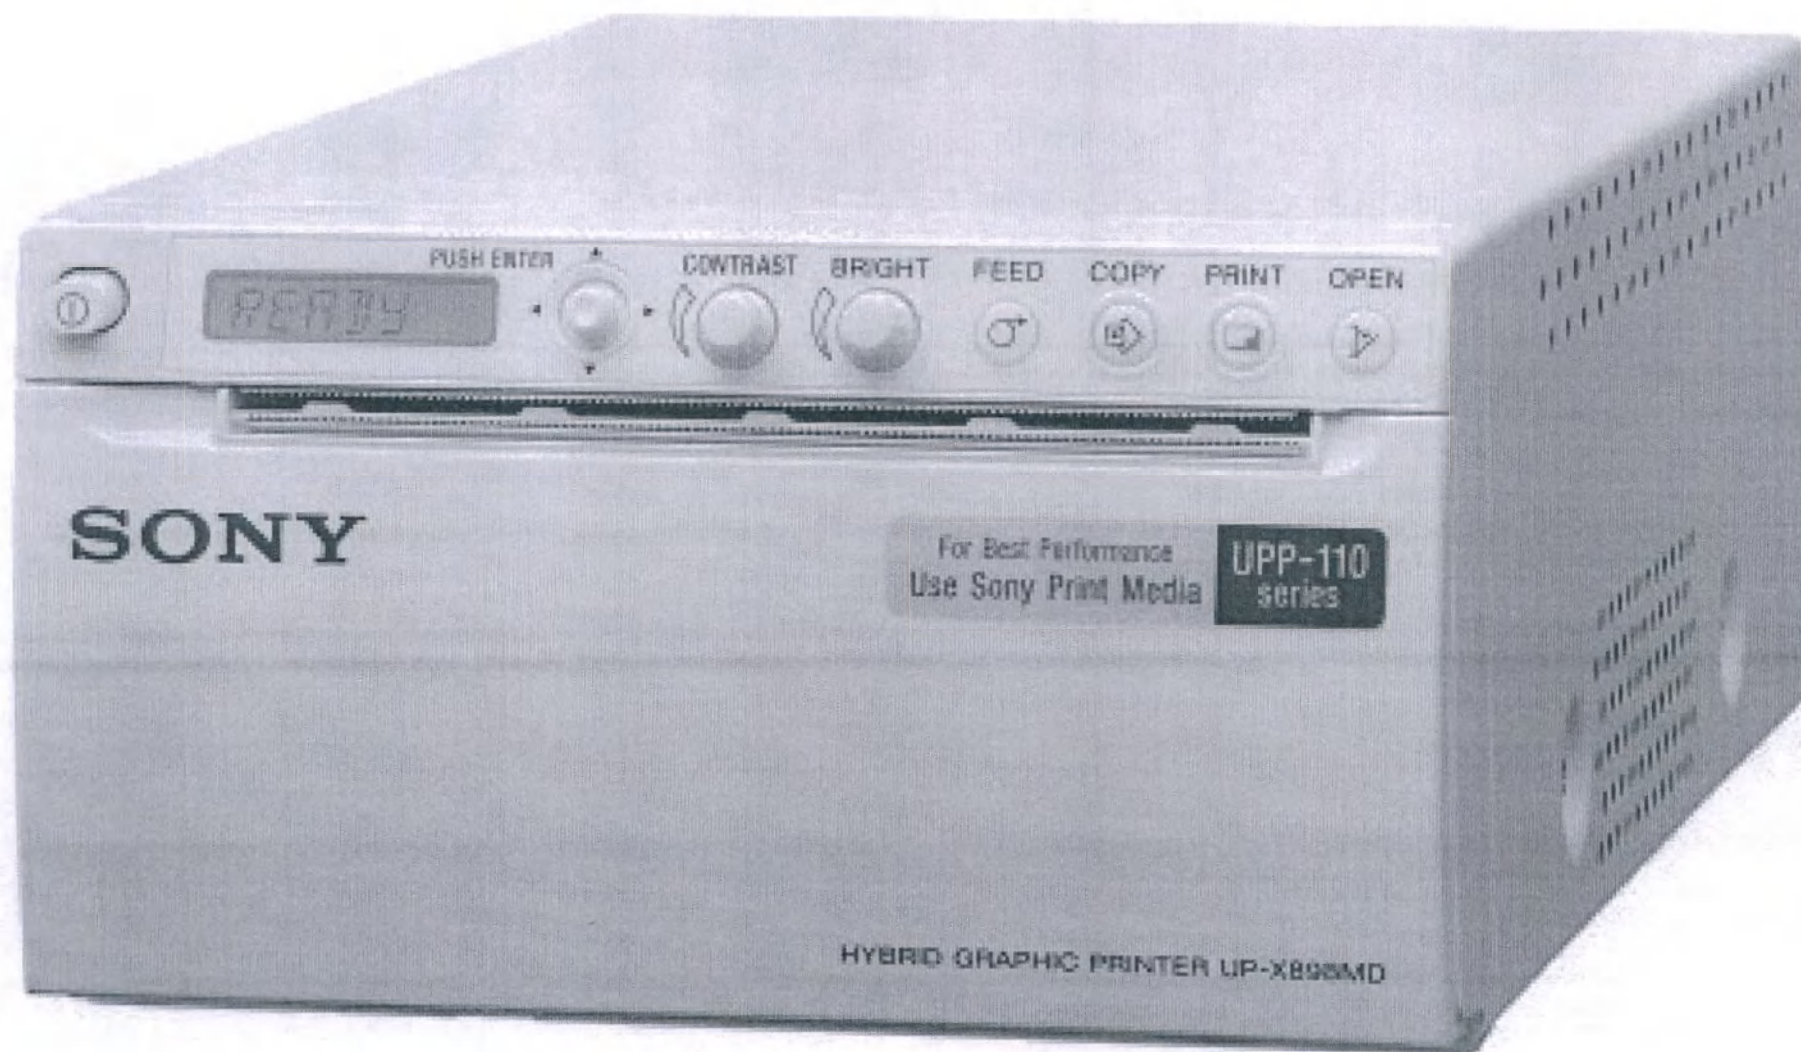

20. Система цифровой рентгенографии CXDI производства Canon Medical System Corporation, Япония;



или NX производства Agfa N.V., Бельгия; или Vxvue производства Vieworks Co., Ltd., Корея;




или Vxvue производства Vieworks Co., Ltd., Корея;




или ArtPix производства Thales Electron Devices SAS., Франция;




или CS производства Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., Япония;

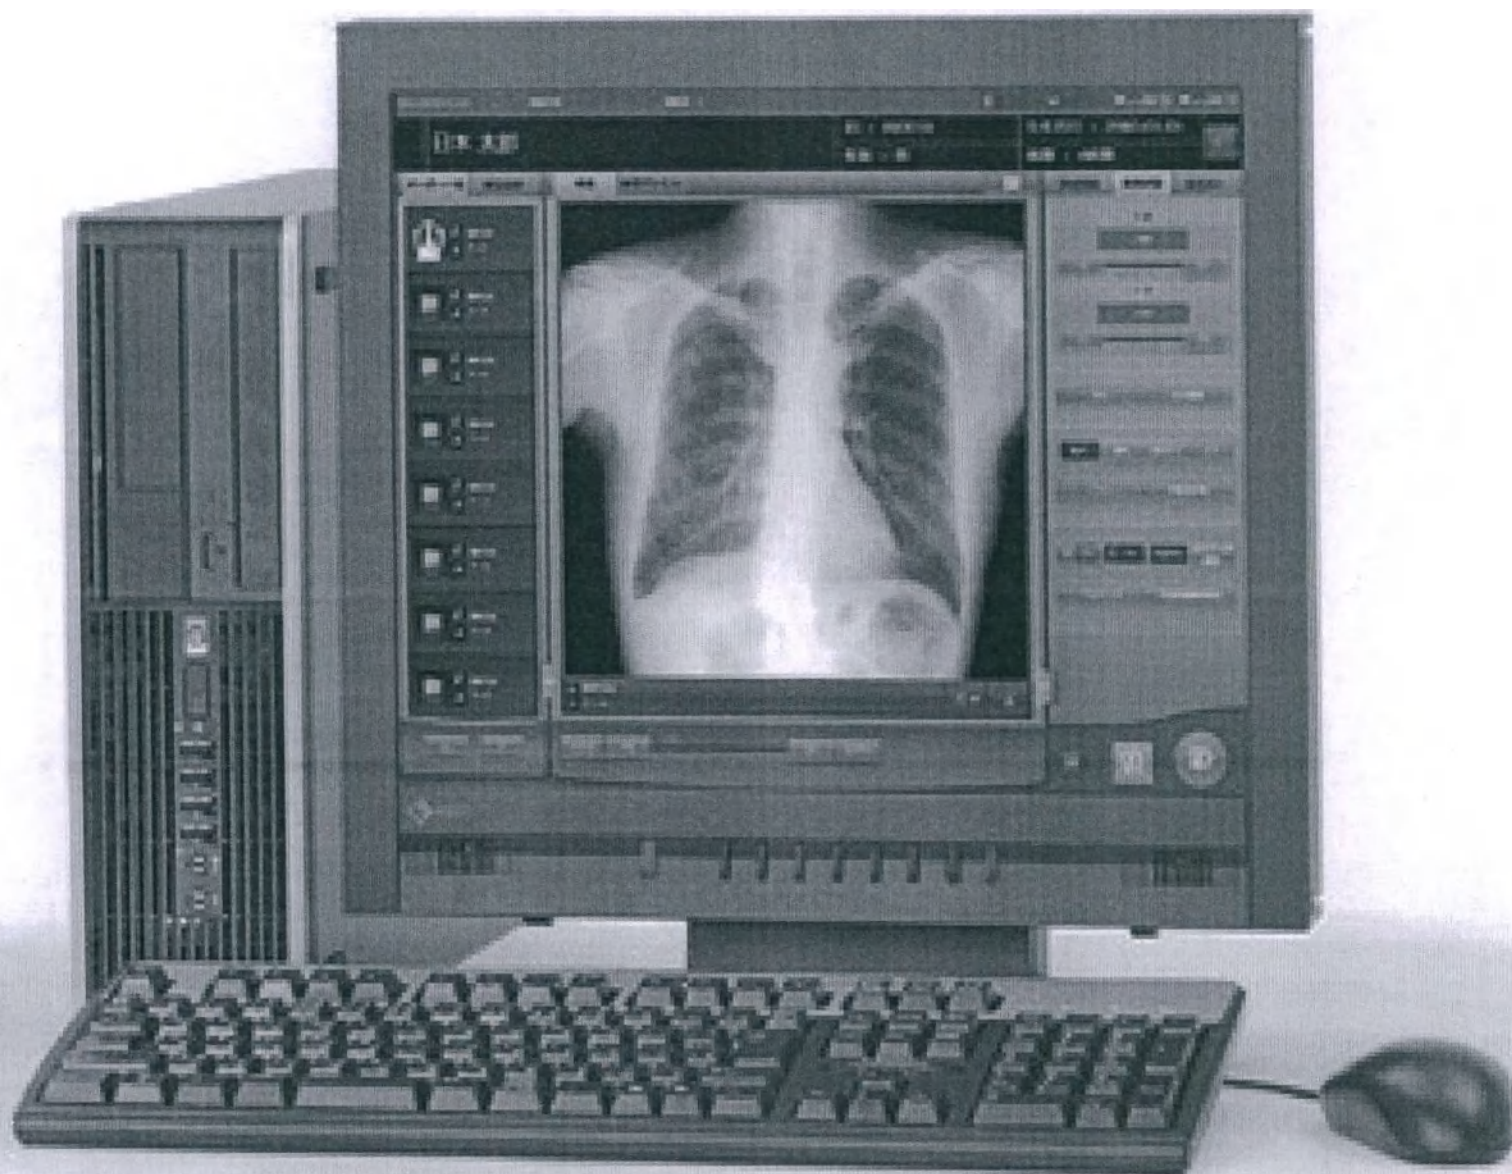


или Nexus DR или DRF производства Varex Imaging Corporation, США;

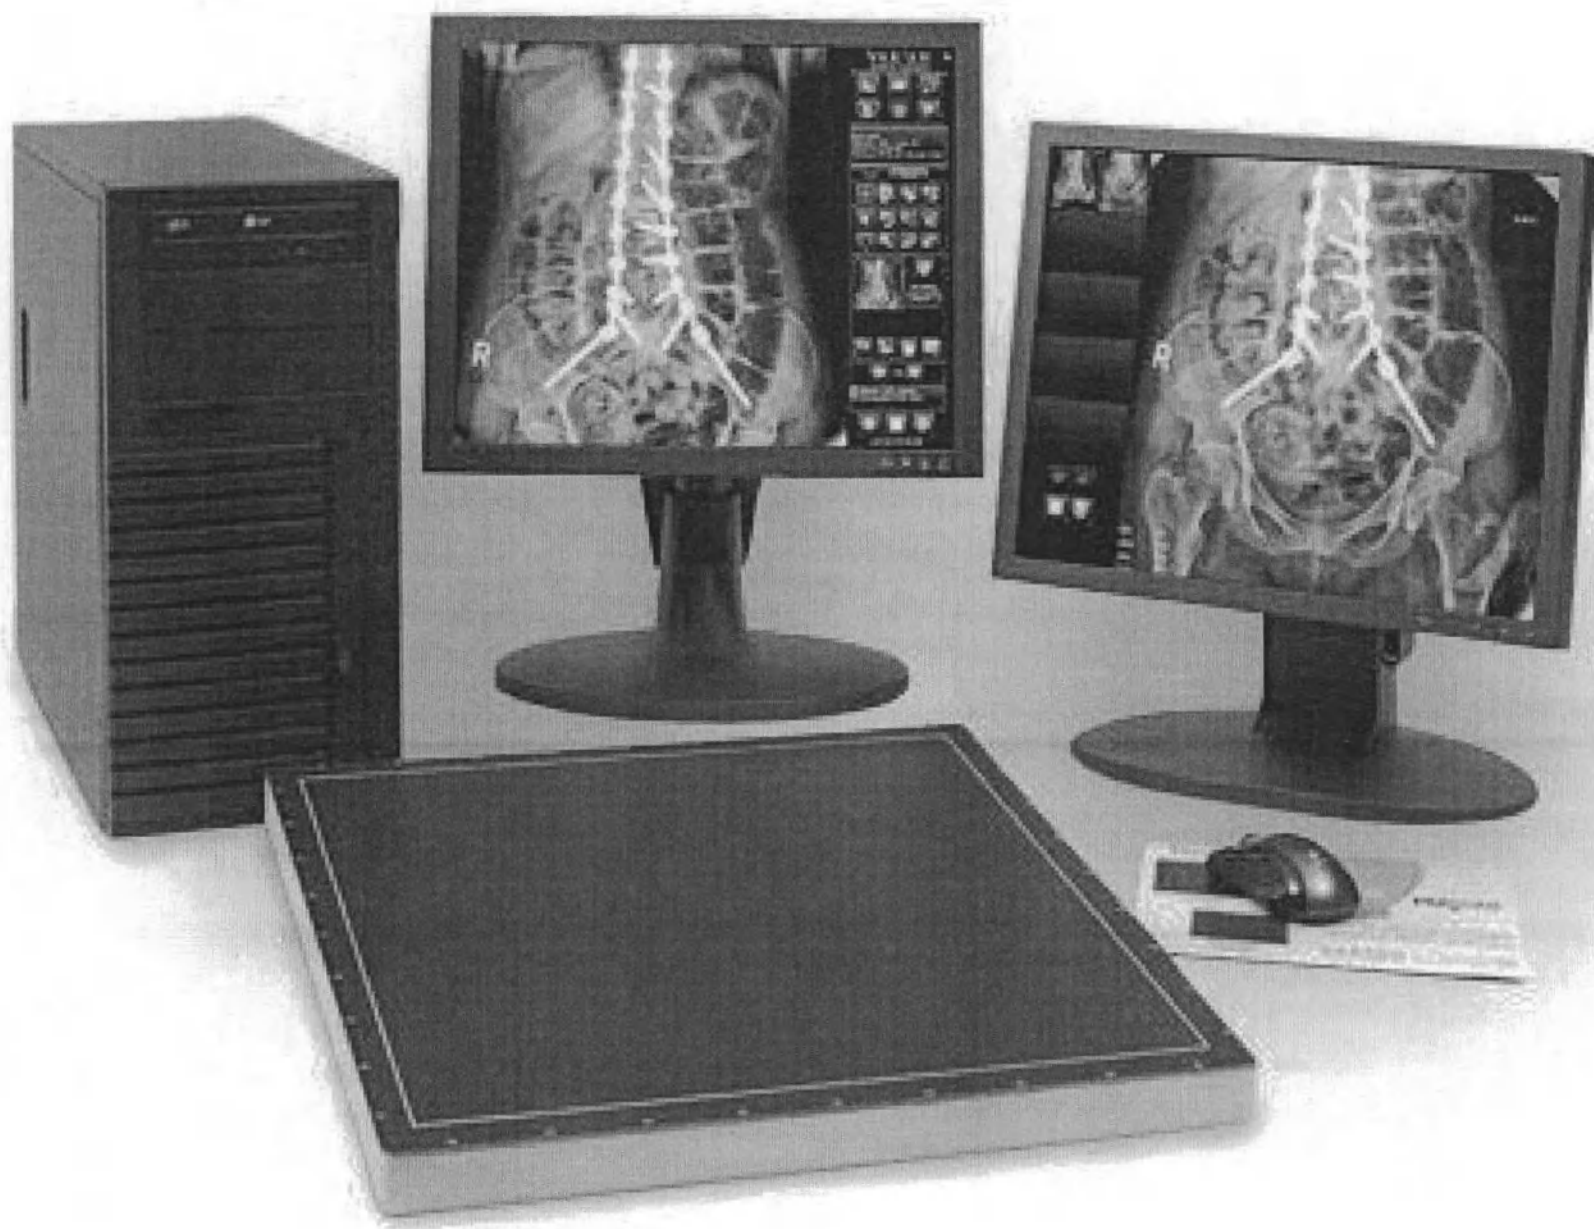


или серии ECONSOLE1, производства DRTECH, Республика Корея;

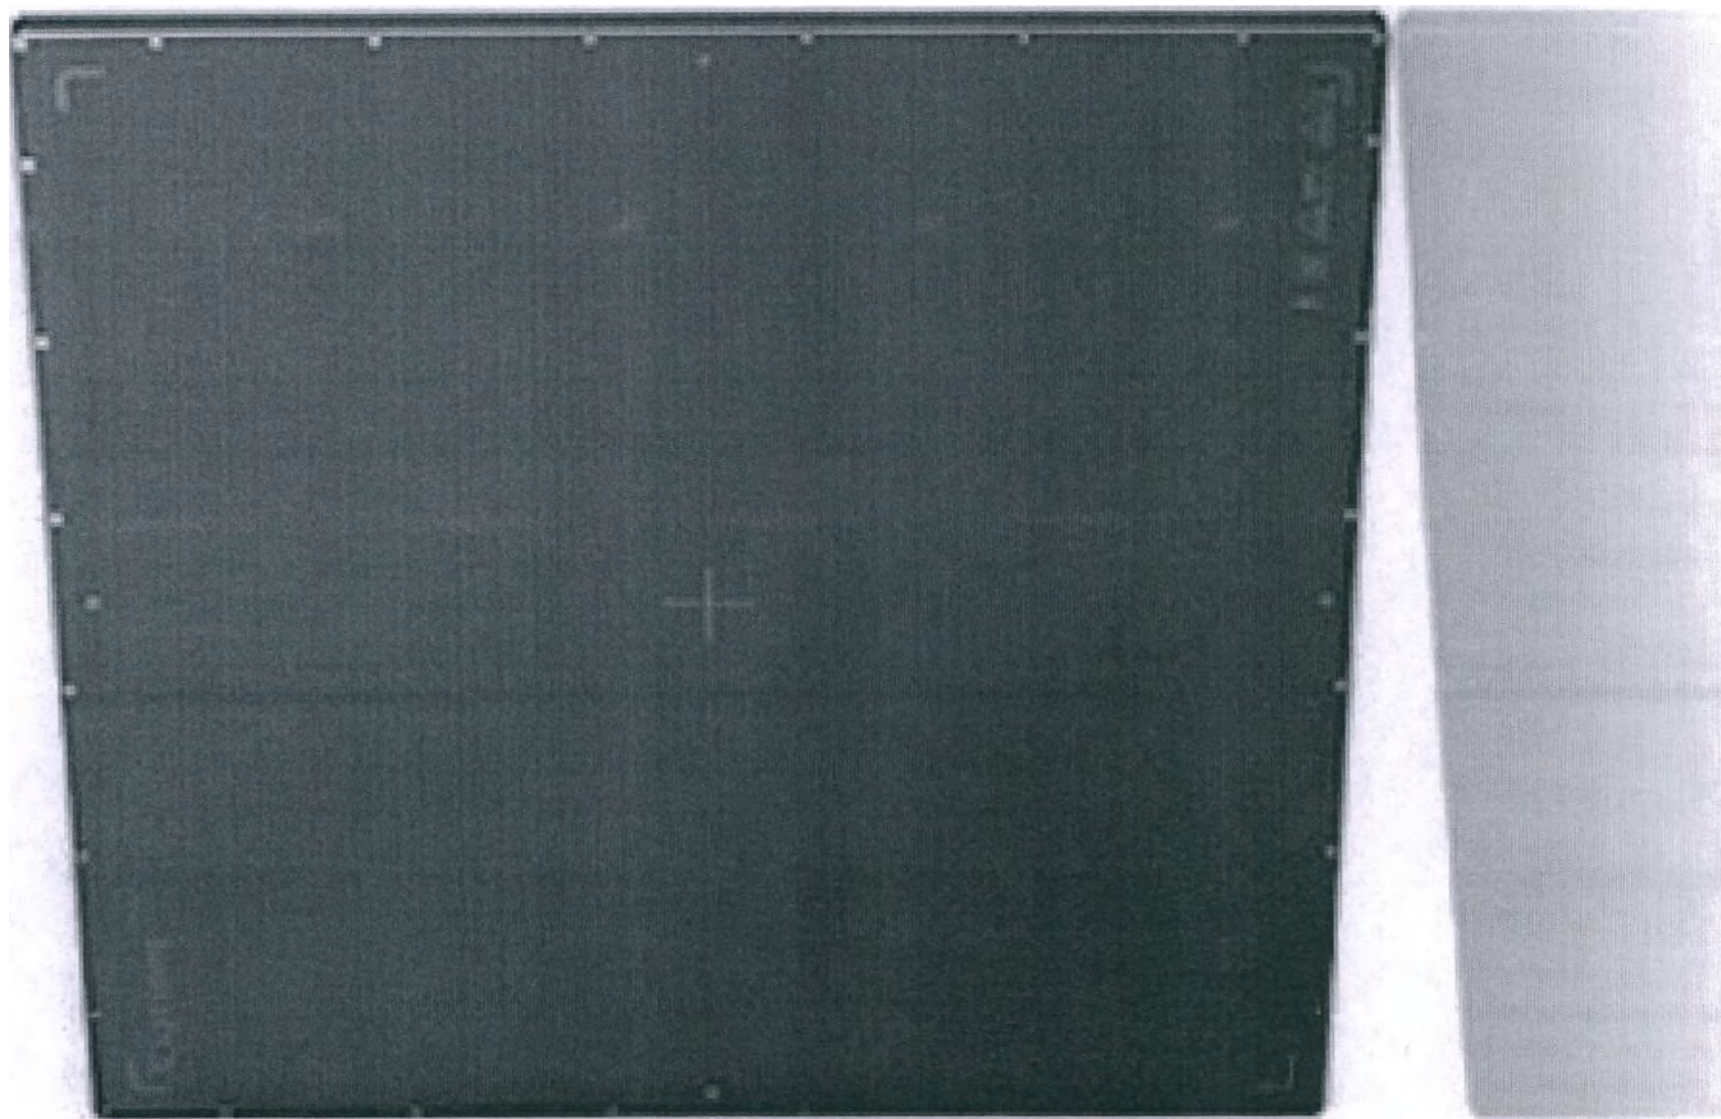


или производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

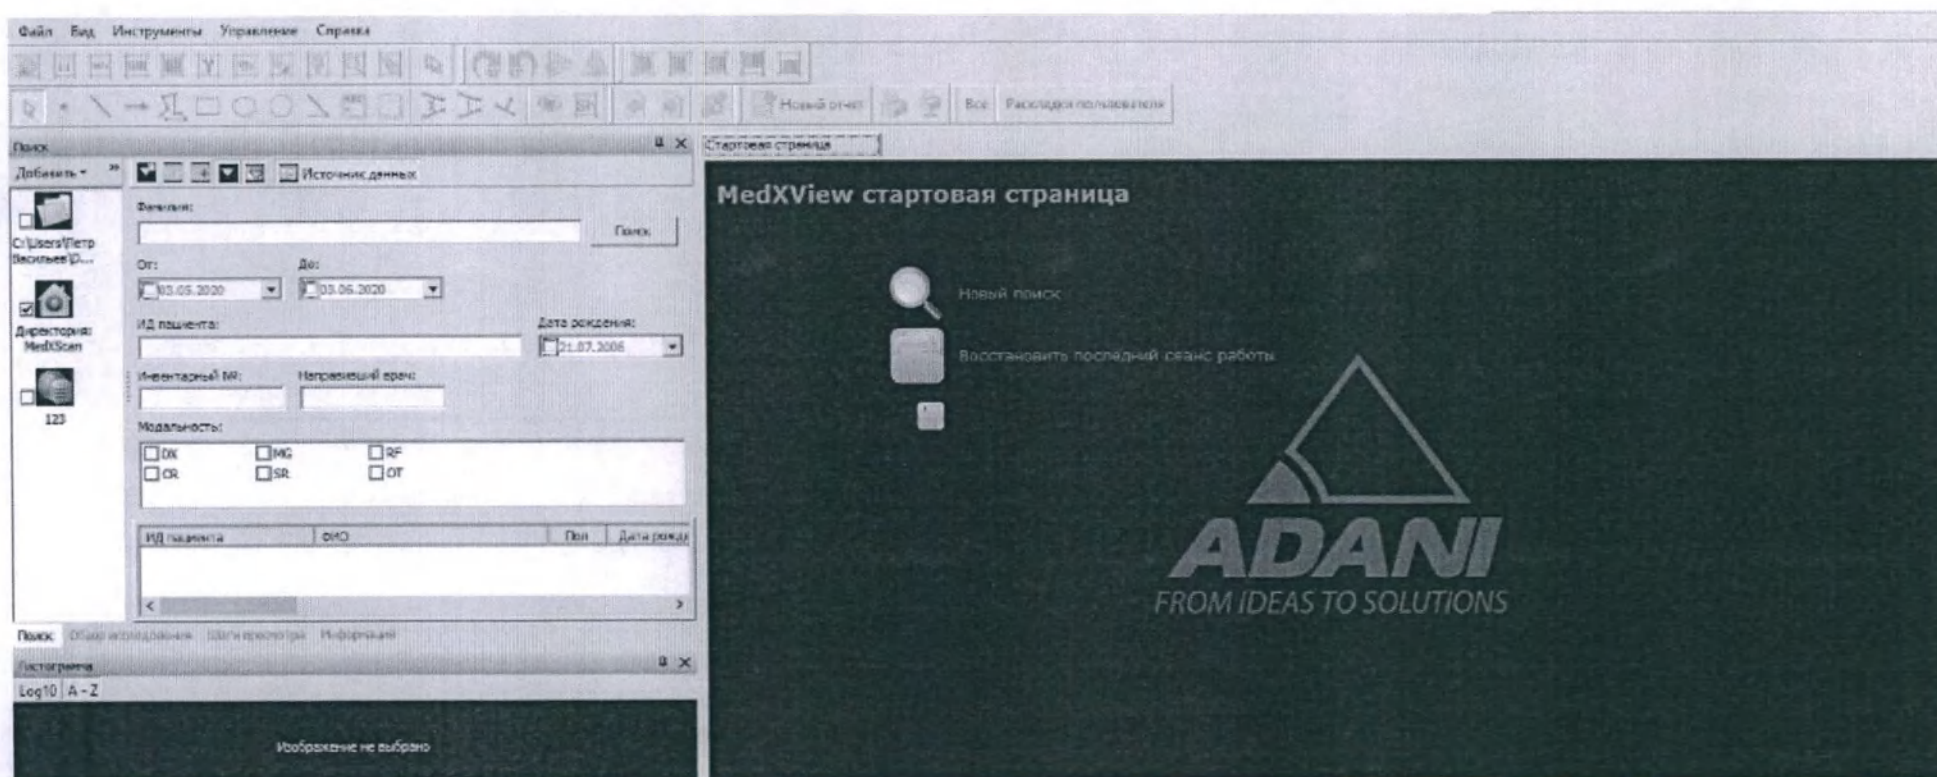


21. Цифровой детектор Pixium производства Thales Electron Devices SAS, Франция;

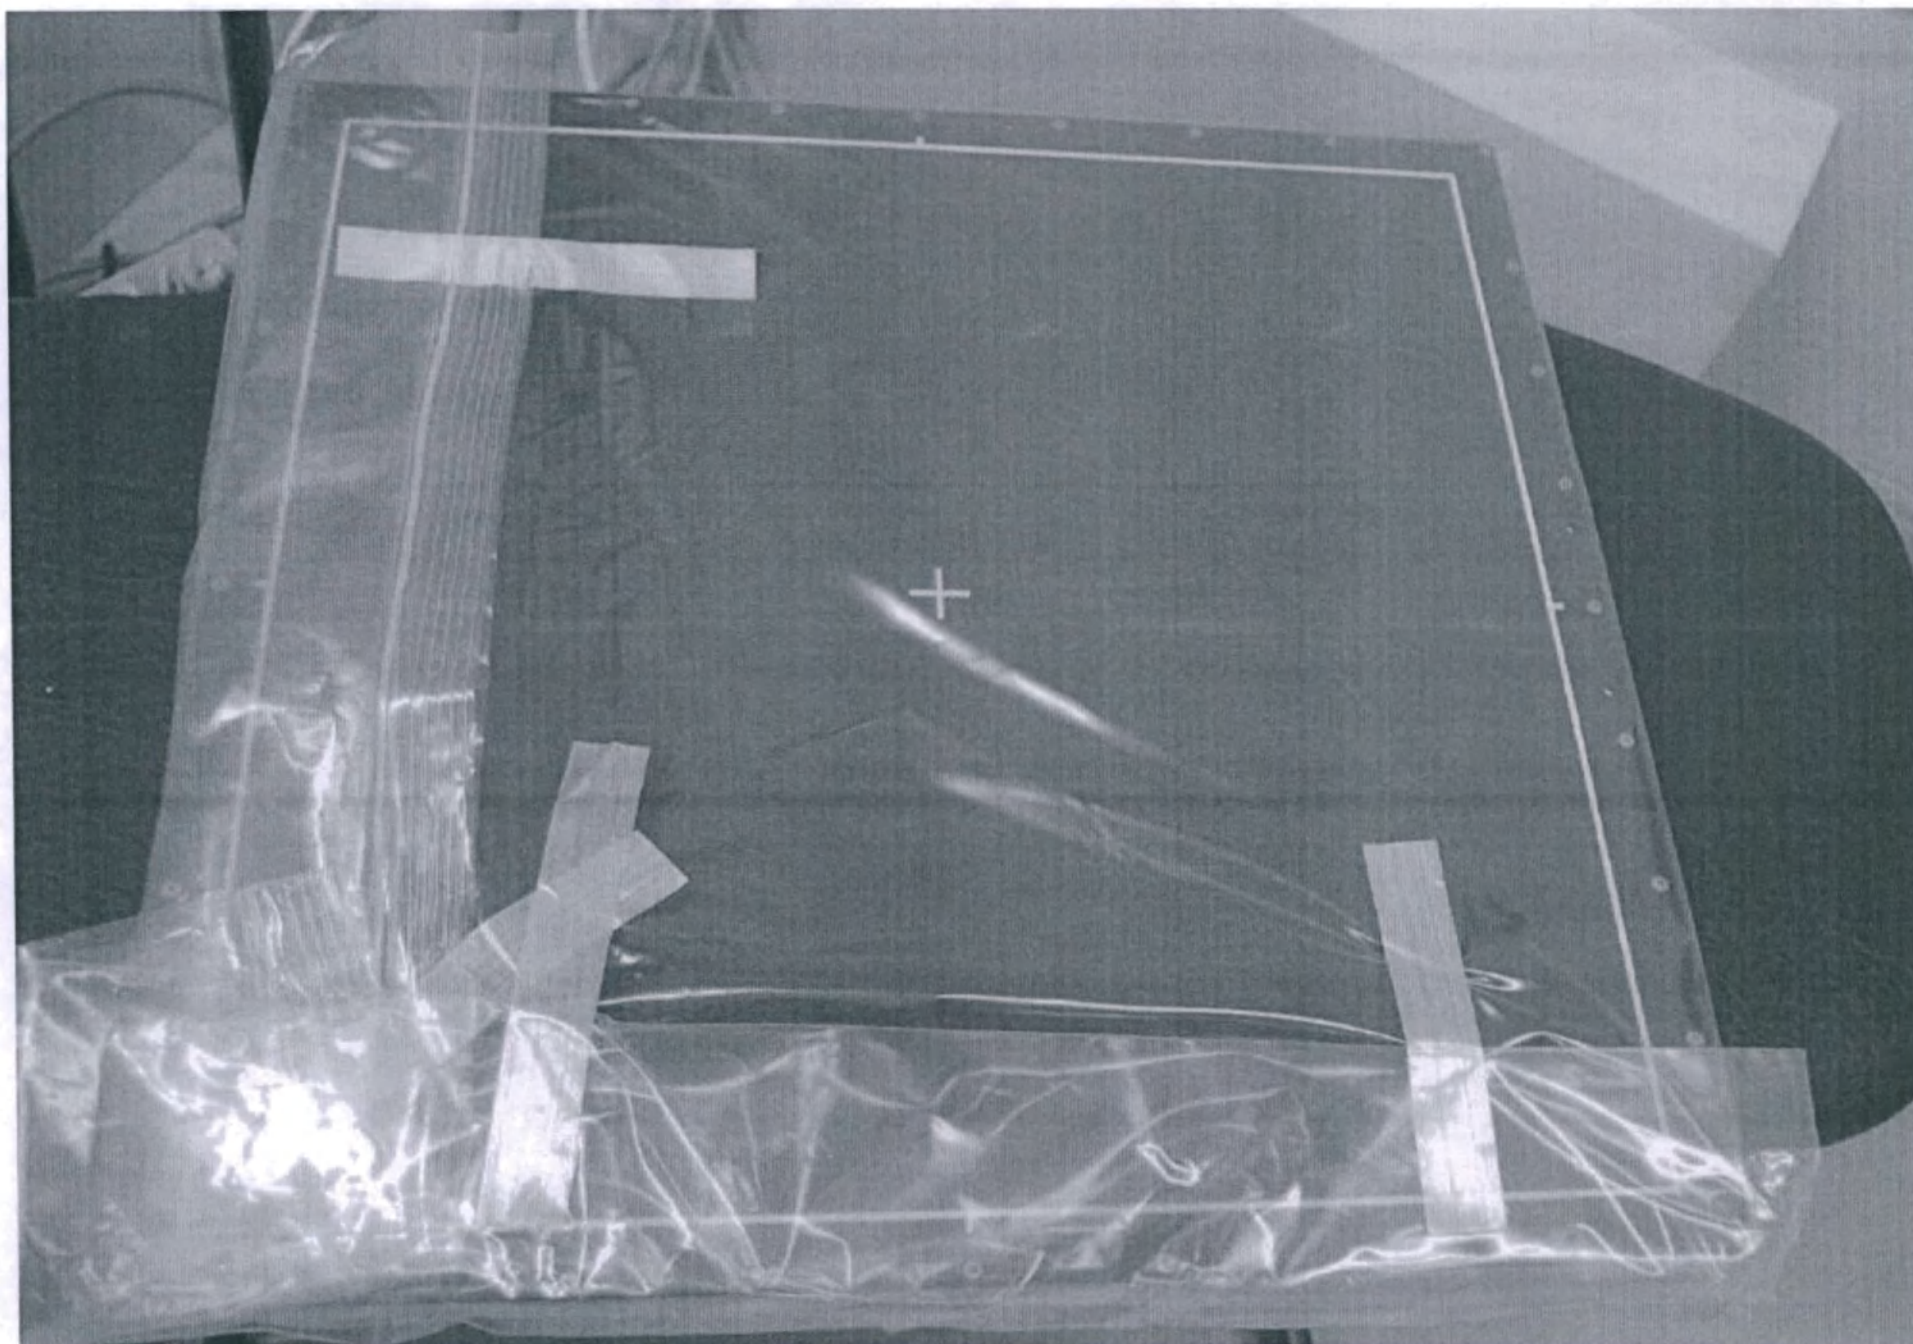


или цифровой приёмник изображения PaxScan или XRpad производства Varex Imaging Corporation, США;

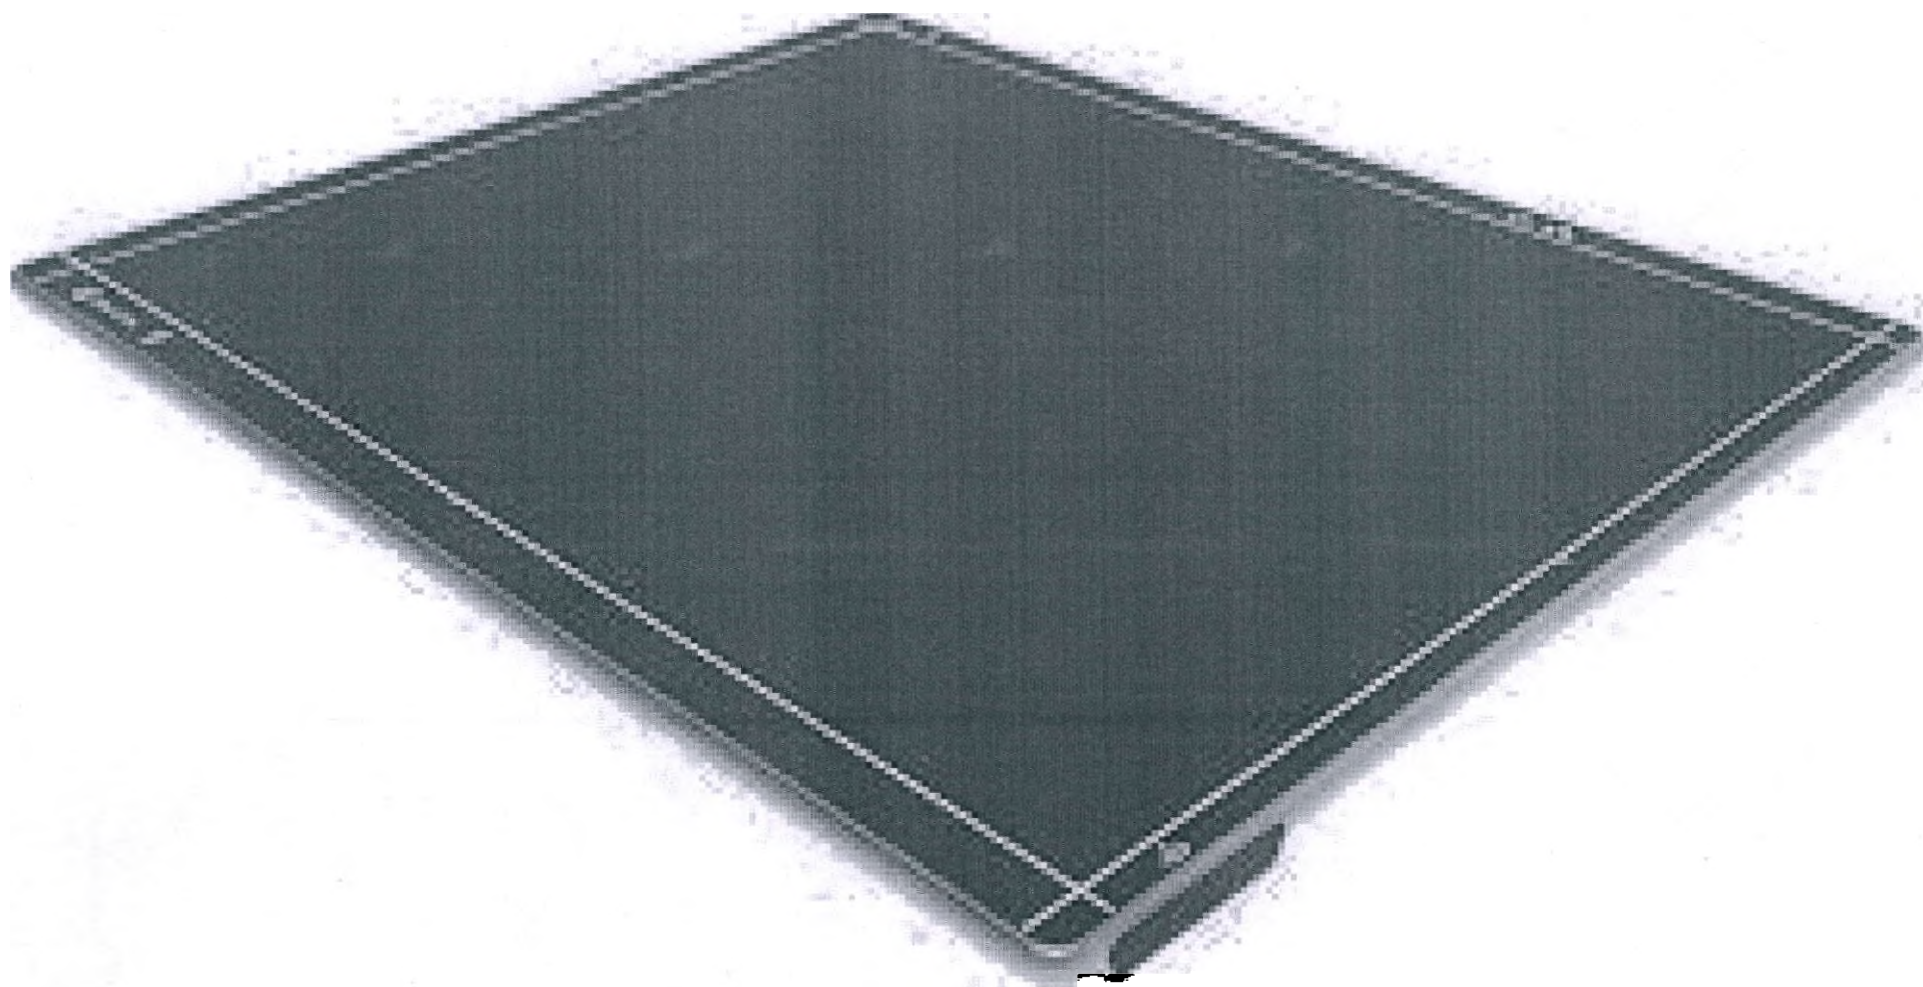

или система цифровой радиологии медицинская диагностическая на основе беспроводного детектора рентгеновского излучения DRX производства Carestream Health Inc., США (РУ № ФСЗ 2012/13085);

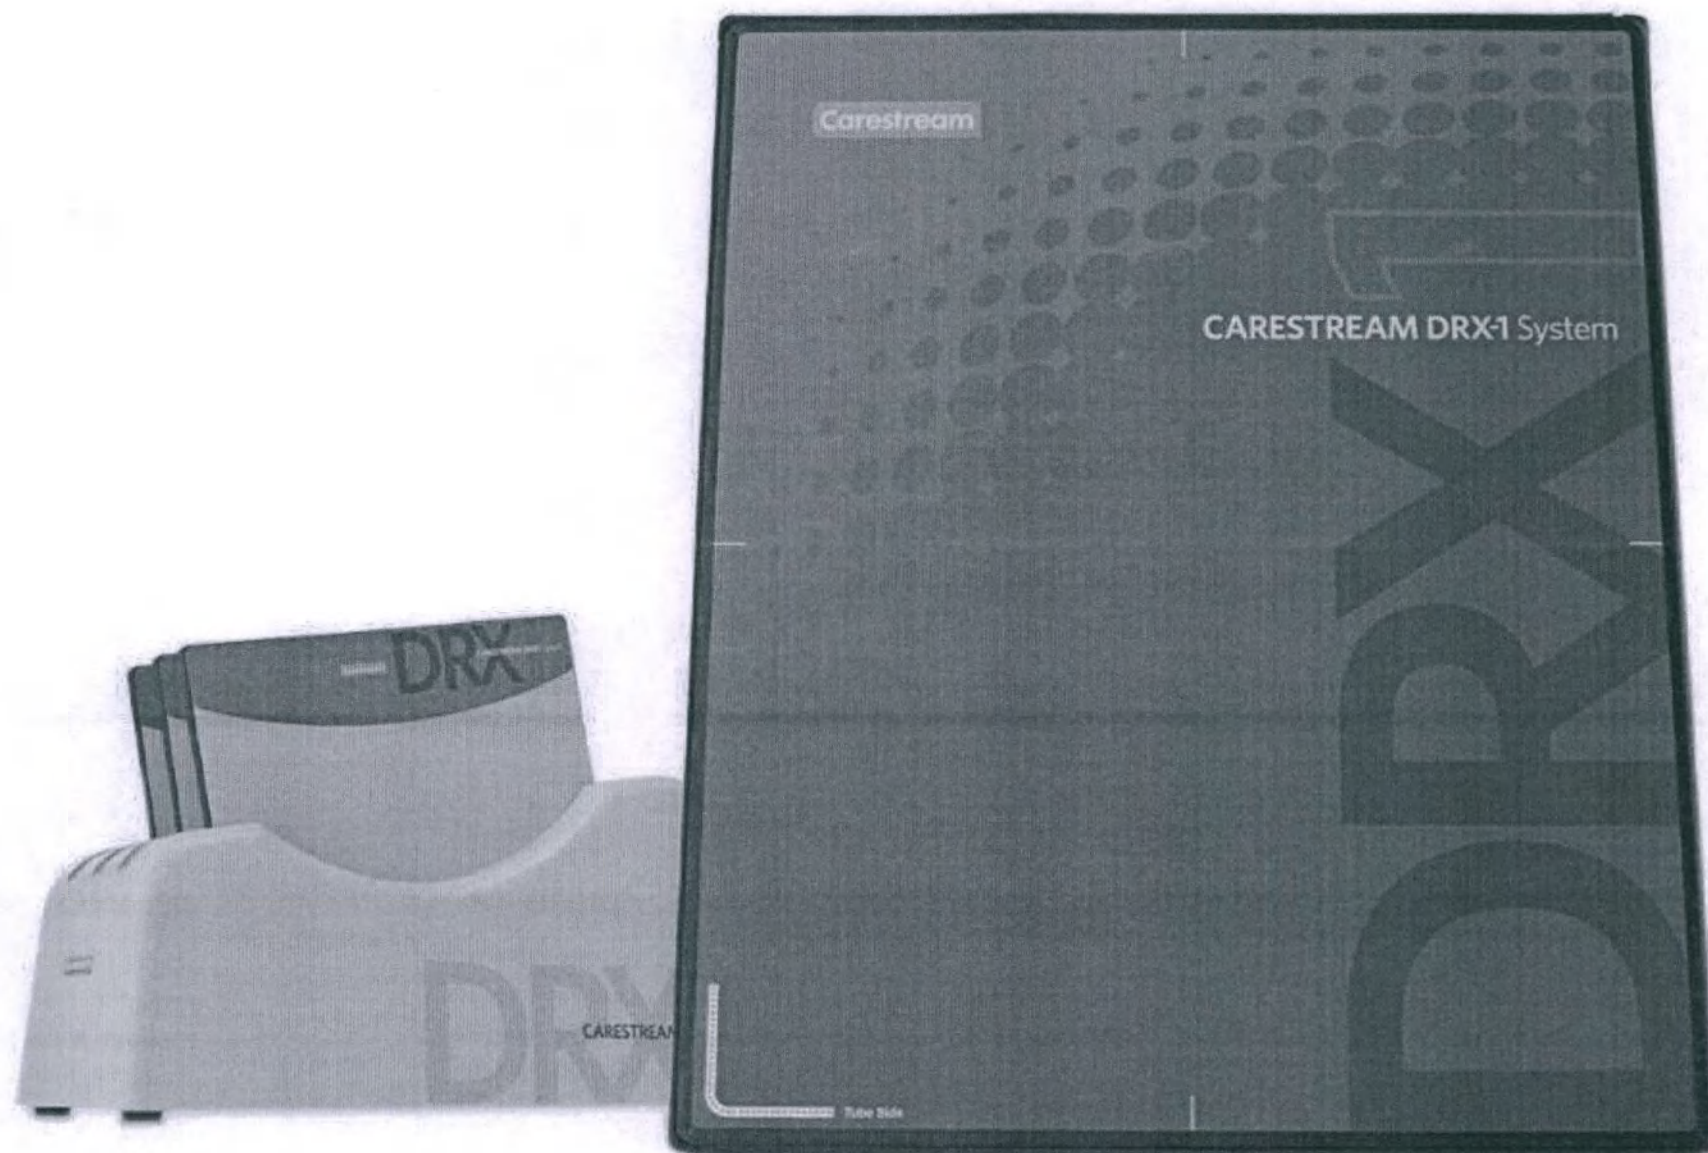


или приёмник рентгенографический цифровой ViVIX-S производства Vieworks Co., Ltd., Республика Корея

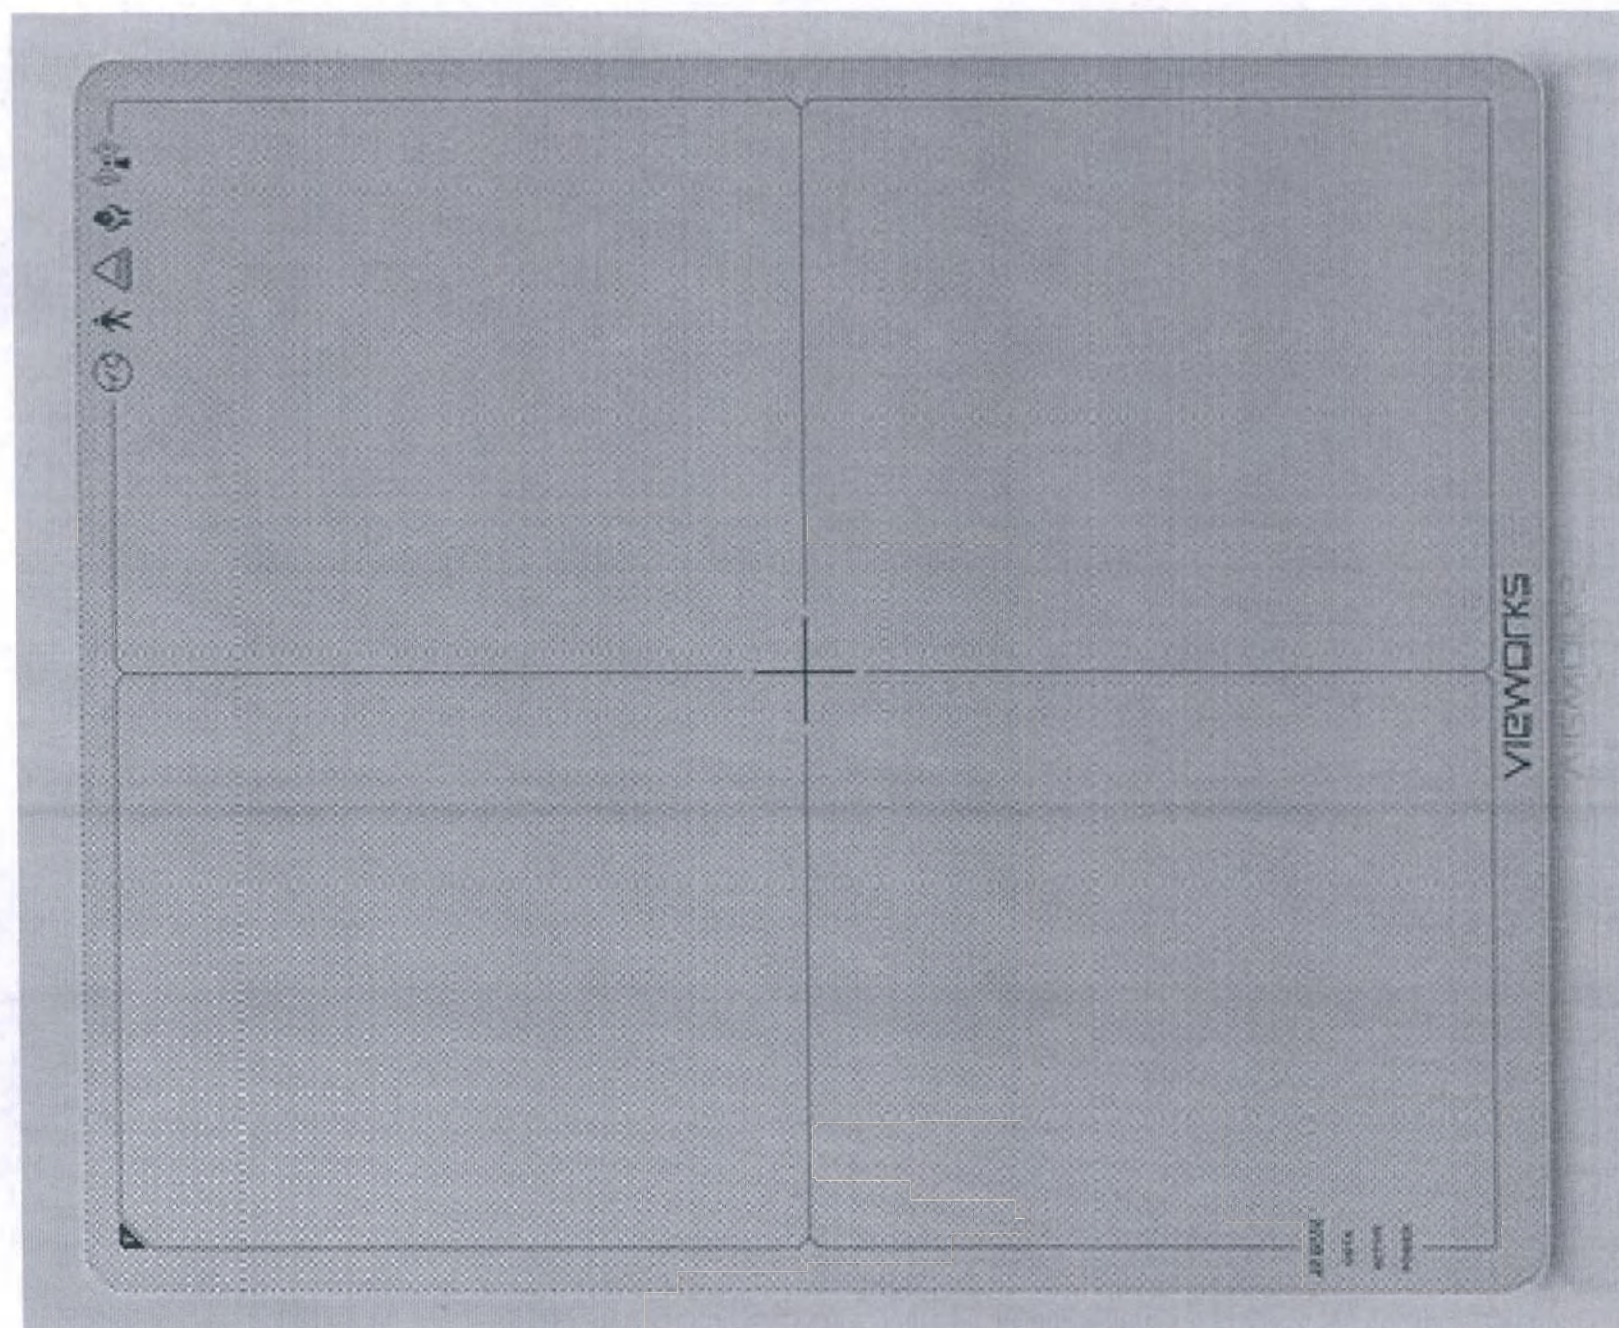


или аппарат цифровой радиологии АэроДР, варианты исполнения: Р-31, Р-51, Р-52 производства Konica Minolta, Inc., Япония (РУ № РЗН 2018/7682);




или EVS производства DRTECH, Республика Корея;

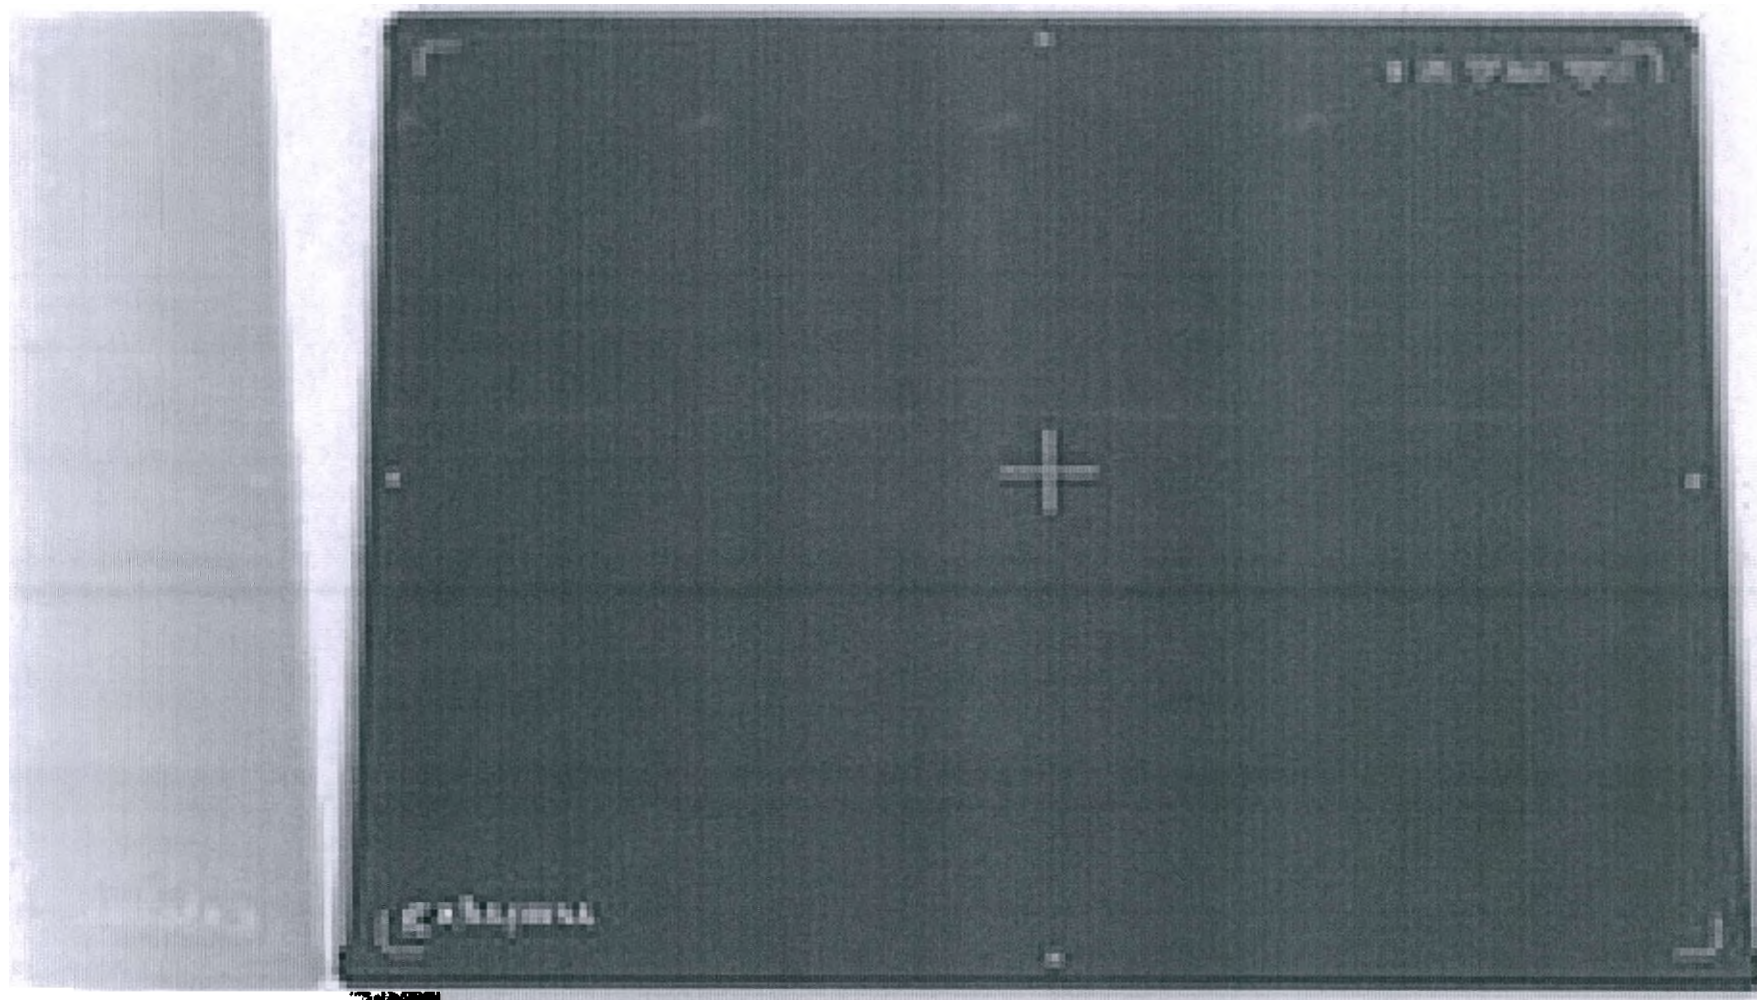


или Mars, Venu производства iRay Technology Co Ltd., Китай;

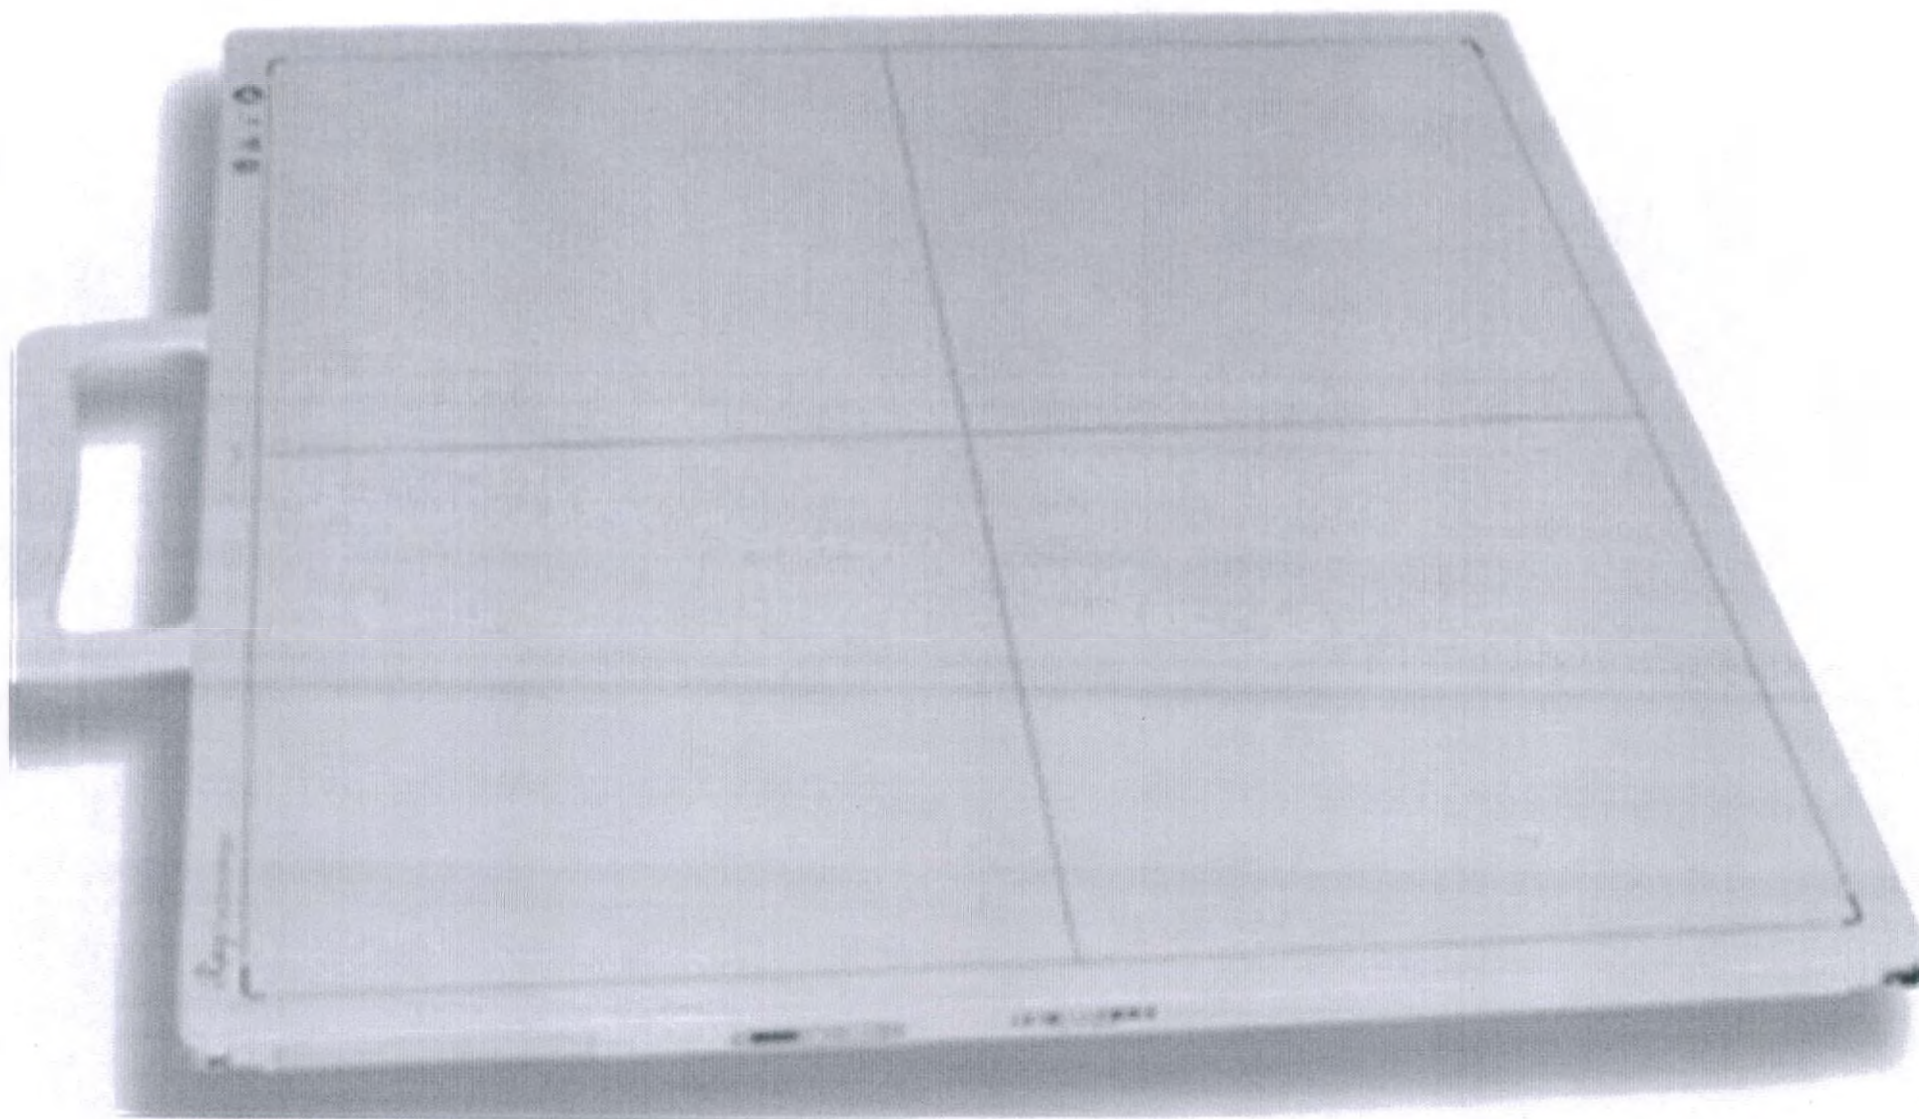


или CareView производства Care Ray Medical System Co, Китай;

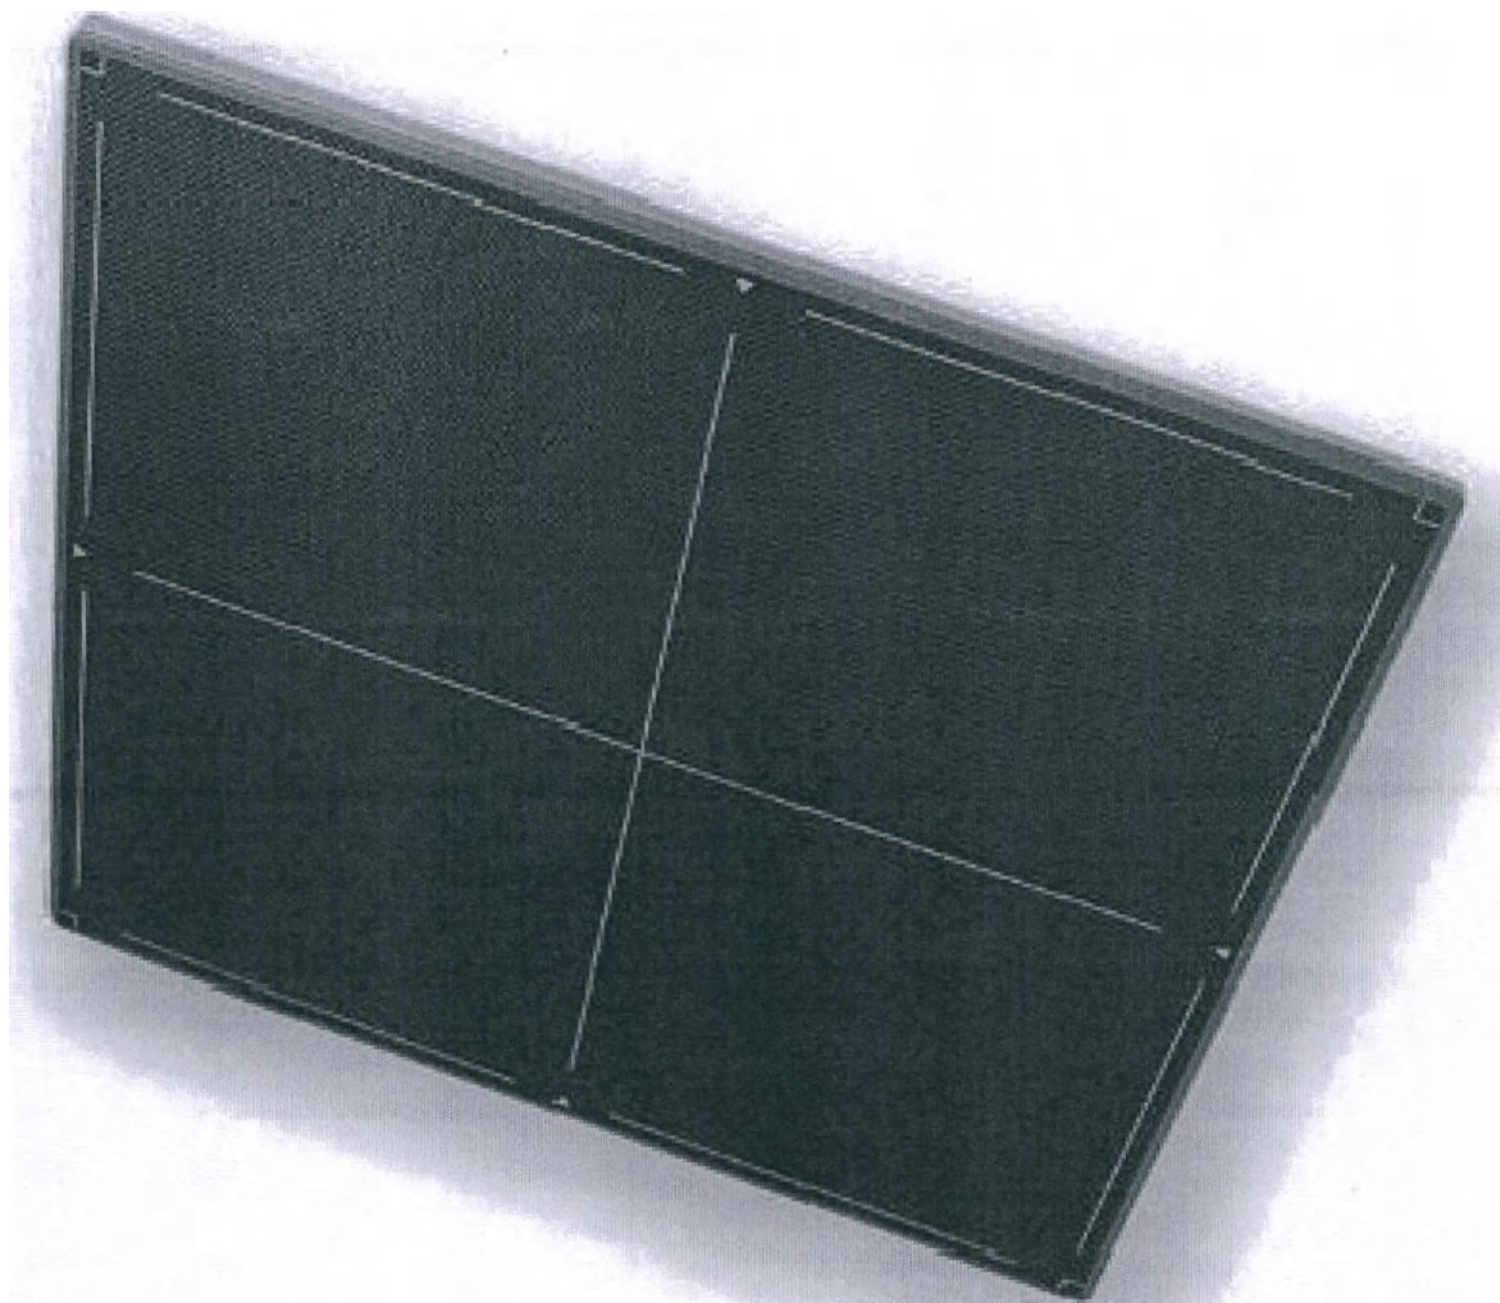

или CXDI производства Canon Medical System Corporation, Япония.

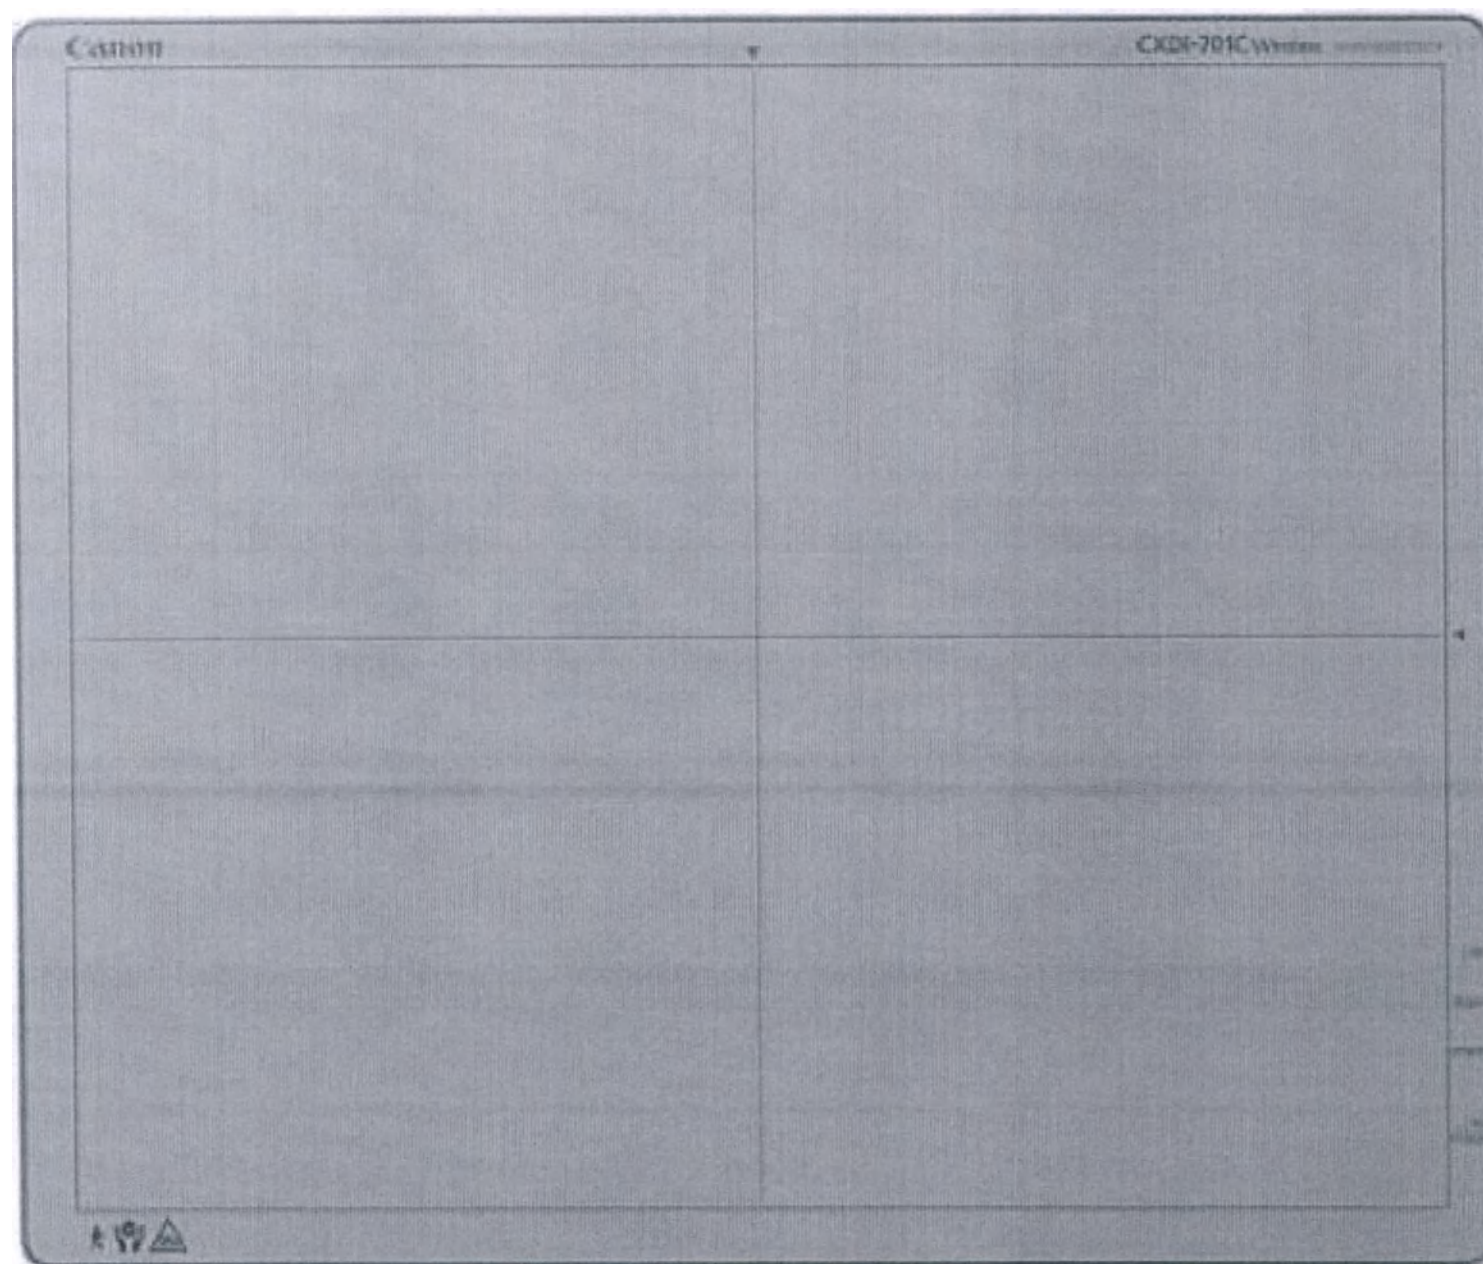


22. Программное обеспечение архива производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь; или программное обеспечение, специализированное «АПК АрхиМед» по ТУ 62.01.29-002-98944313-2015 производства ООО «МЕД-РЕЙ», Российская Федерация (РУ № РЗН 2019/8485); или комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 (РУ № РЗН 2017/5621) или комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по ТУ 9442-233-38226244-2015 (РЗН 2017/5616) производства ООО «ЛИНС», Российская Федерация.

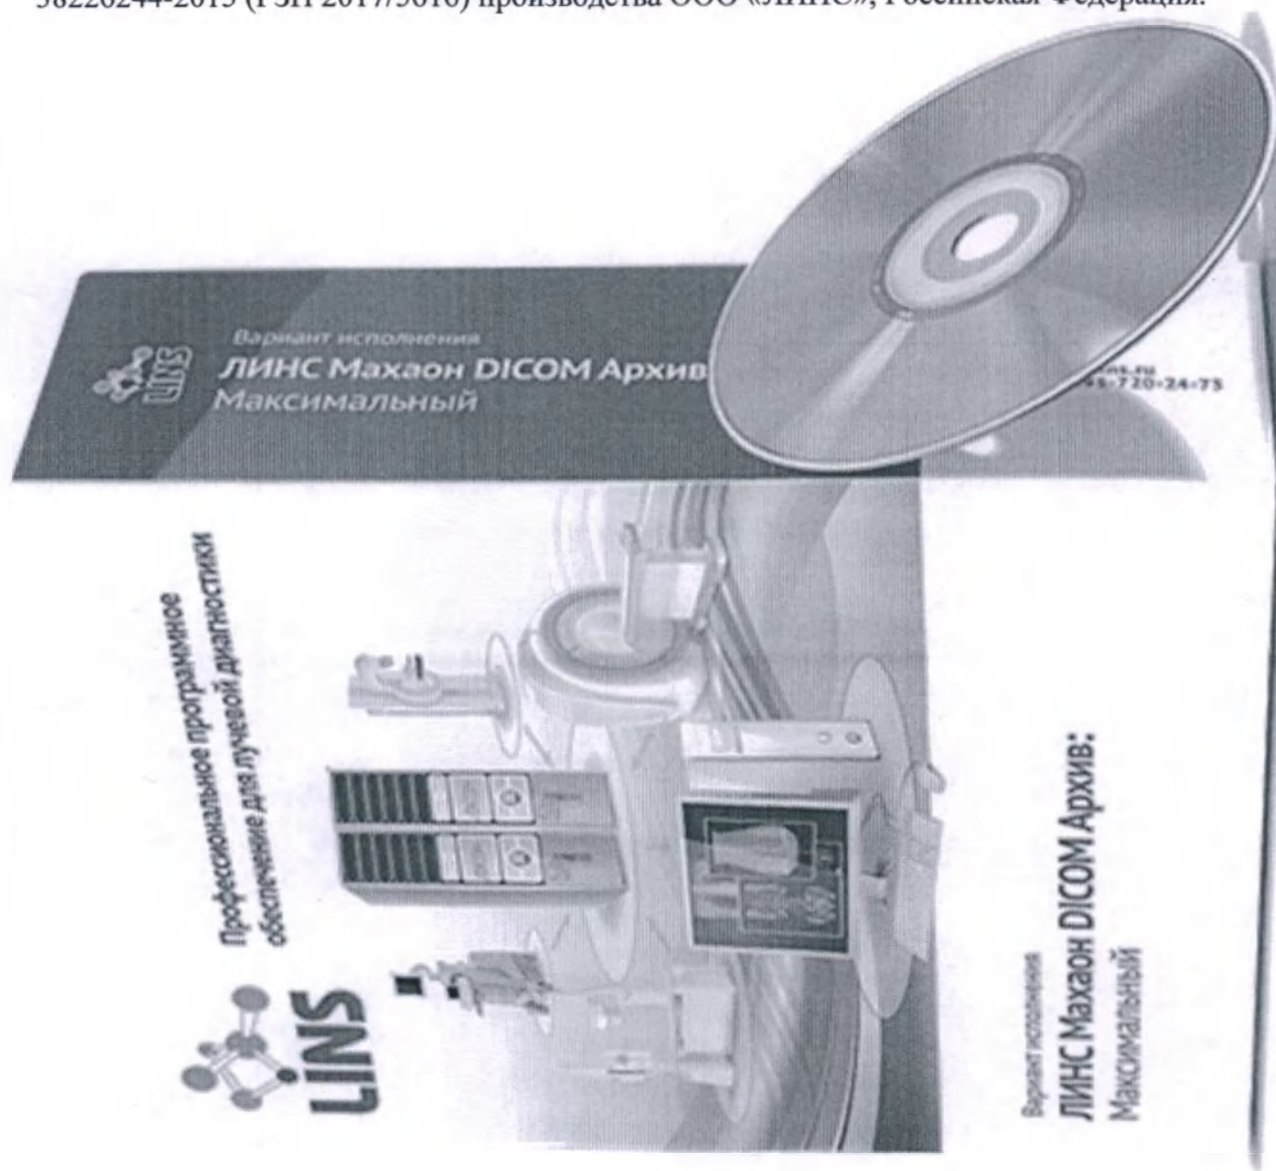


23. Автоматизированное рабочее место (АРМ) производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.




24. Негатоскоп «ИКСВЬЮ» по ТУ 9441-023-74487176-2011 производства ООО «ДИКСИОН», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/11086);

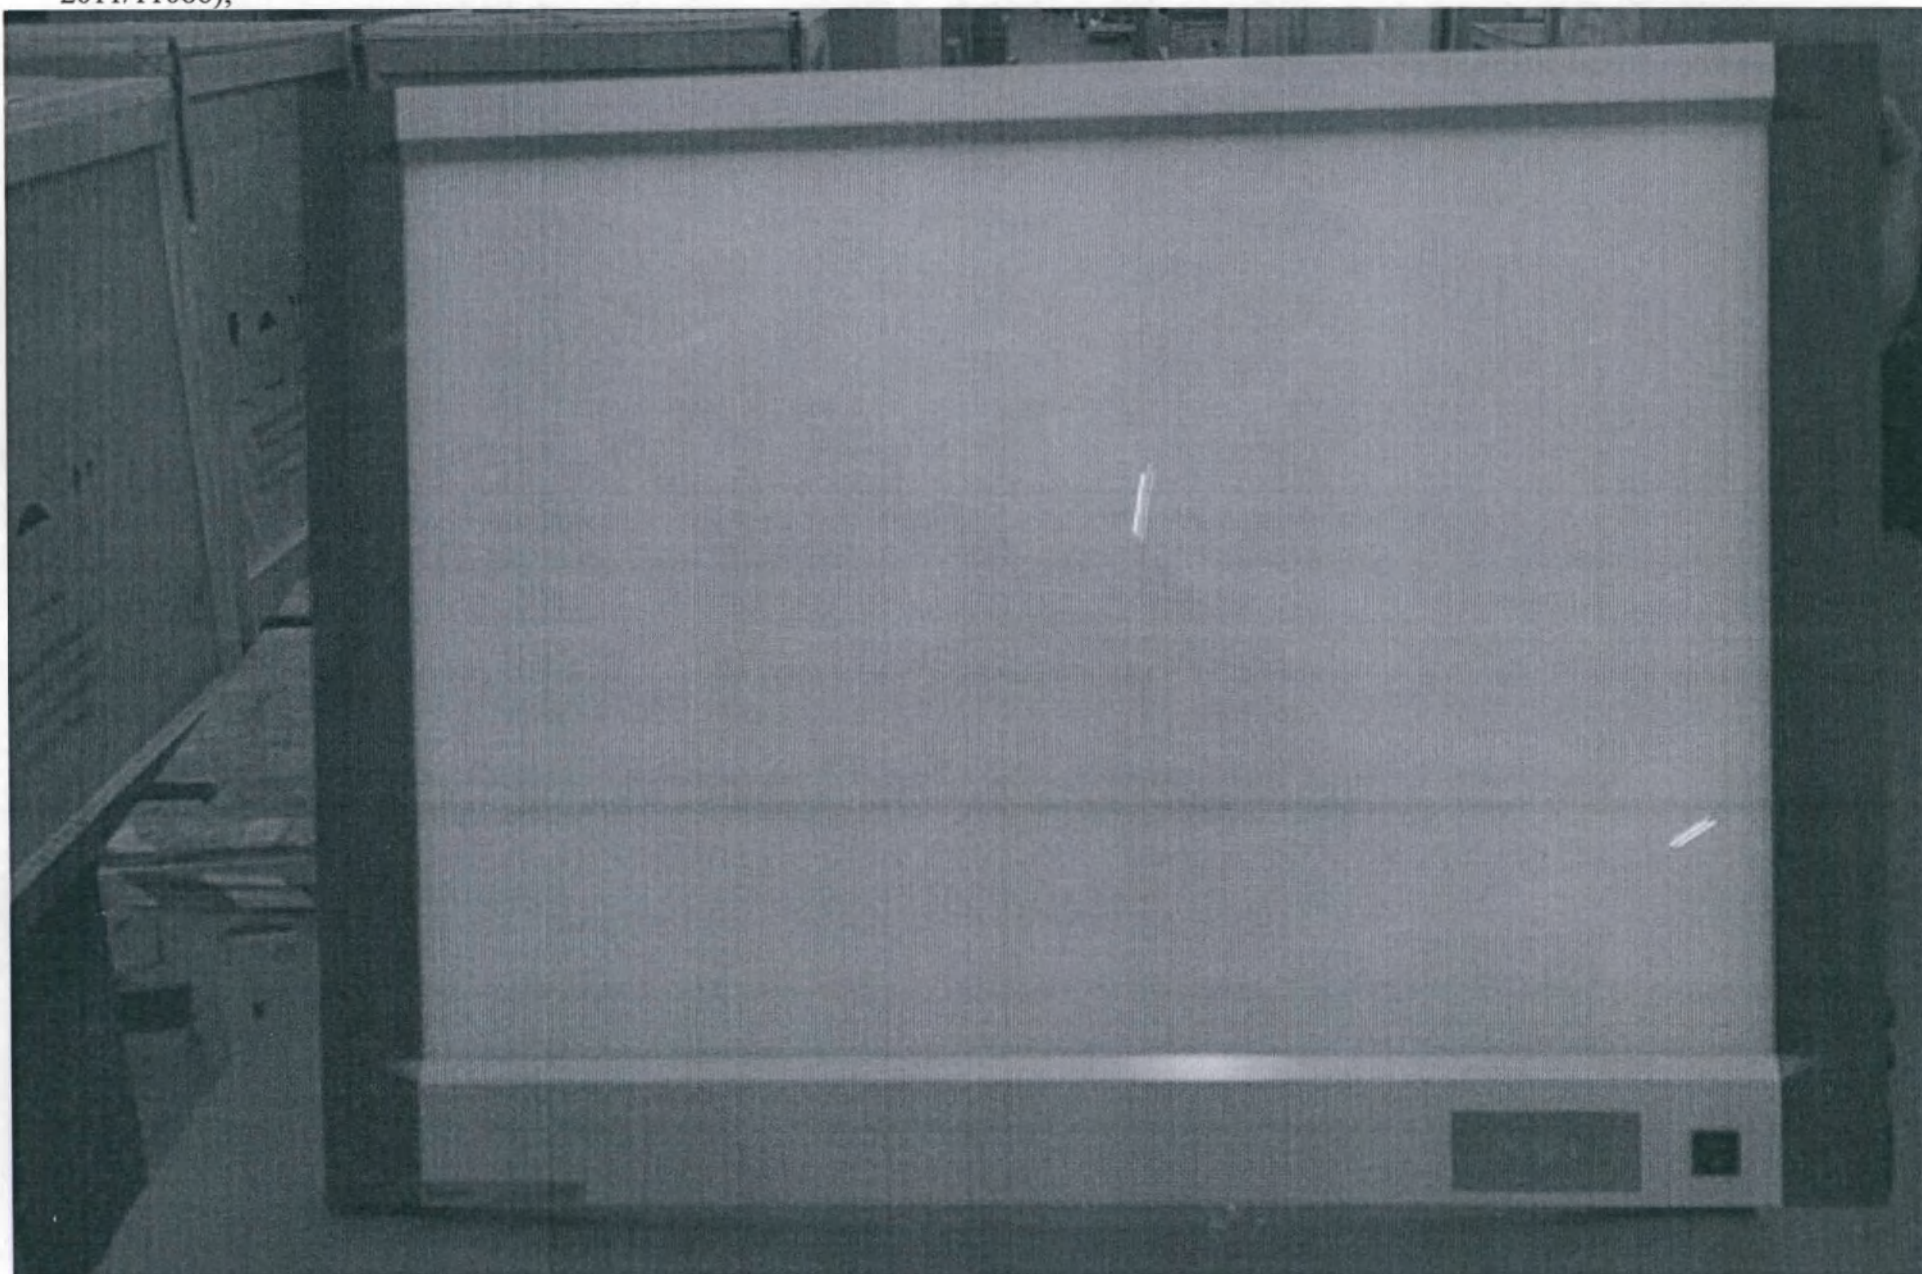


или негатоскоп общего назначения Нег-Н-РМ по ТУ 9452-001-46782692-99 производства ООО «Рентген-Комплект» (РУ № ФСР 2008/02874);

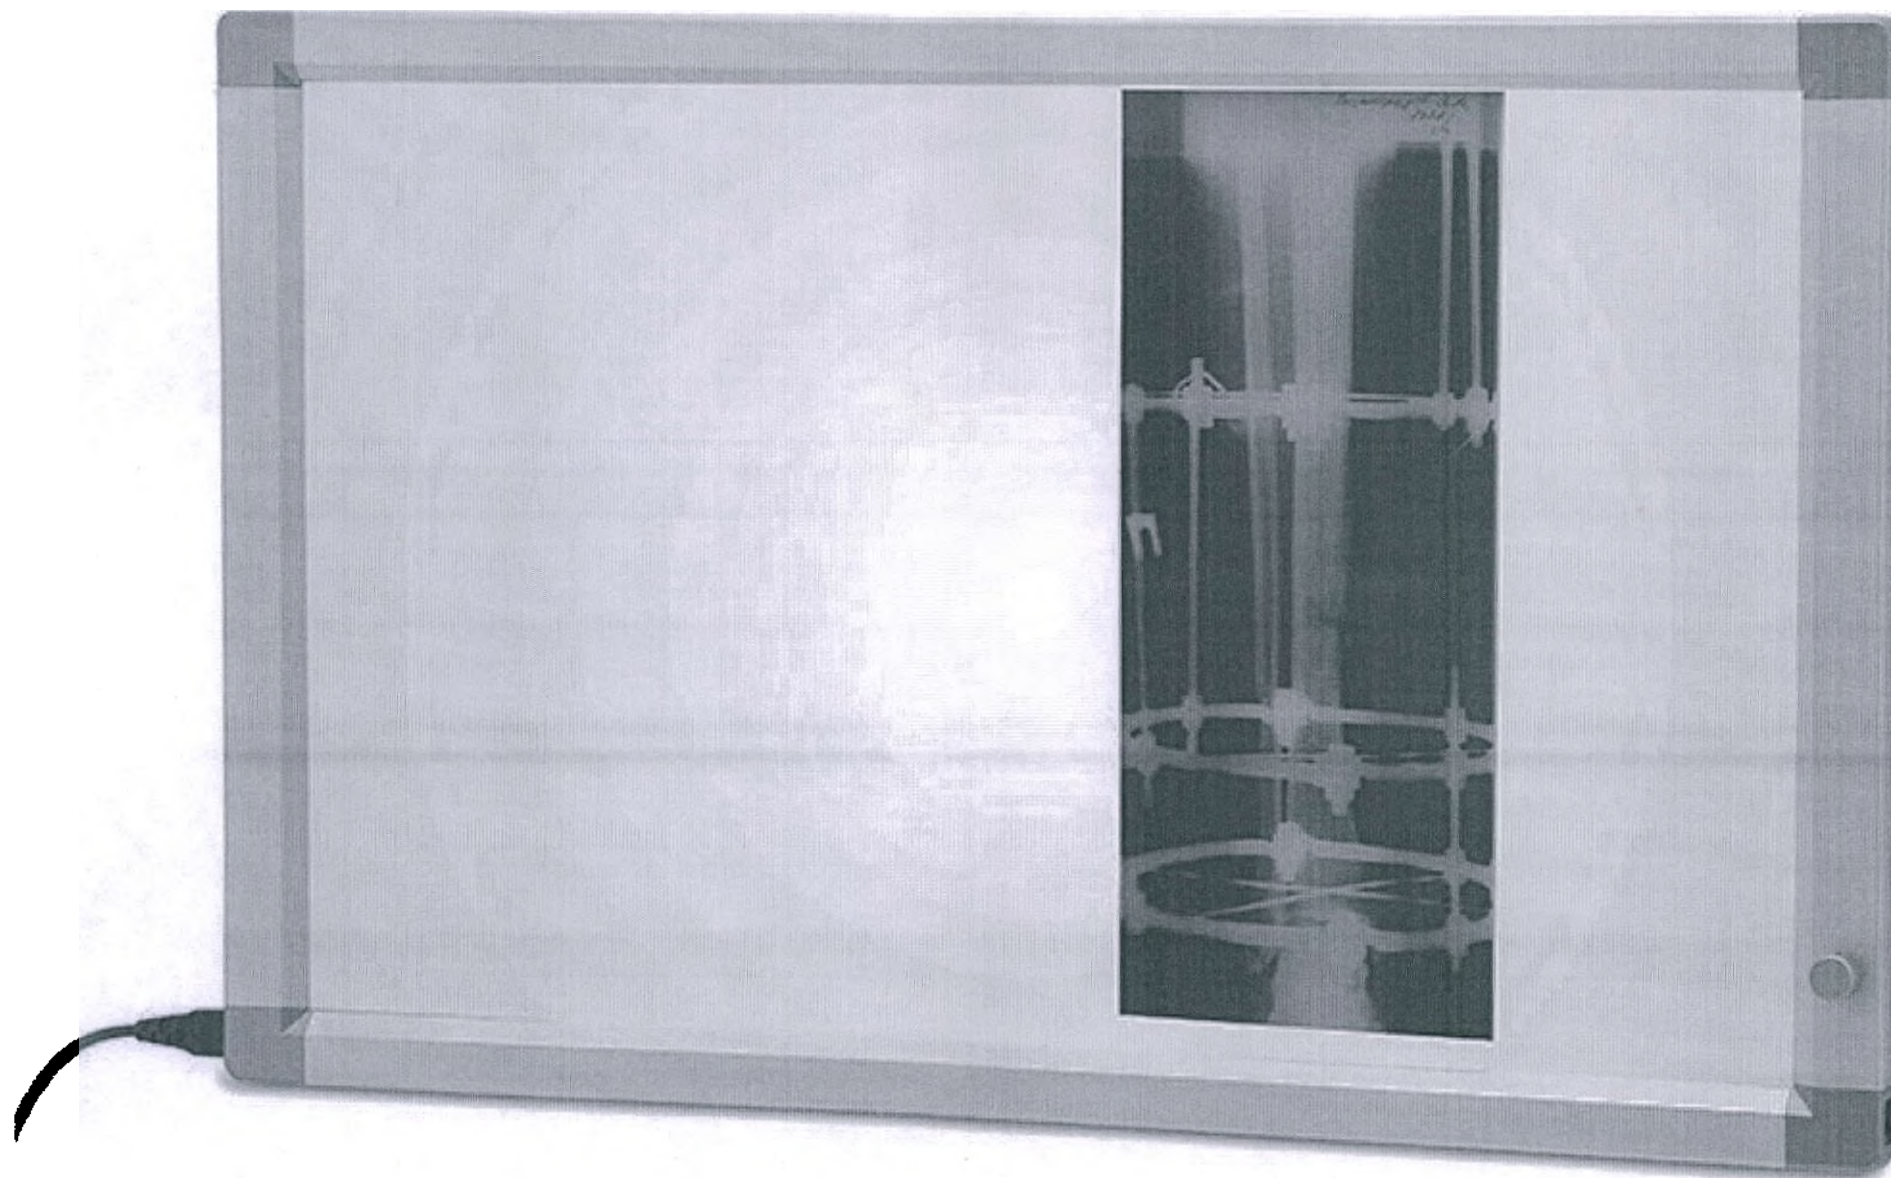


или негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011 производства ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований» (РУ № ФСР 2011/10889);

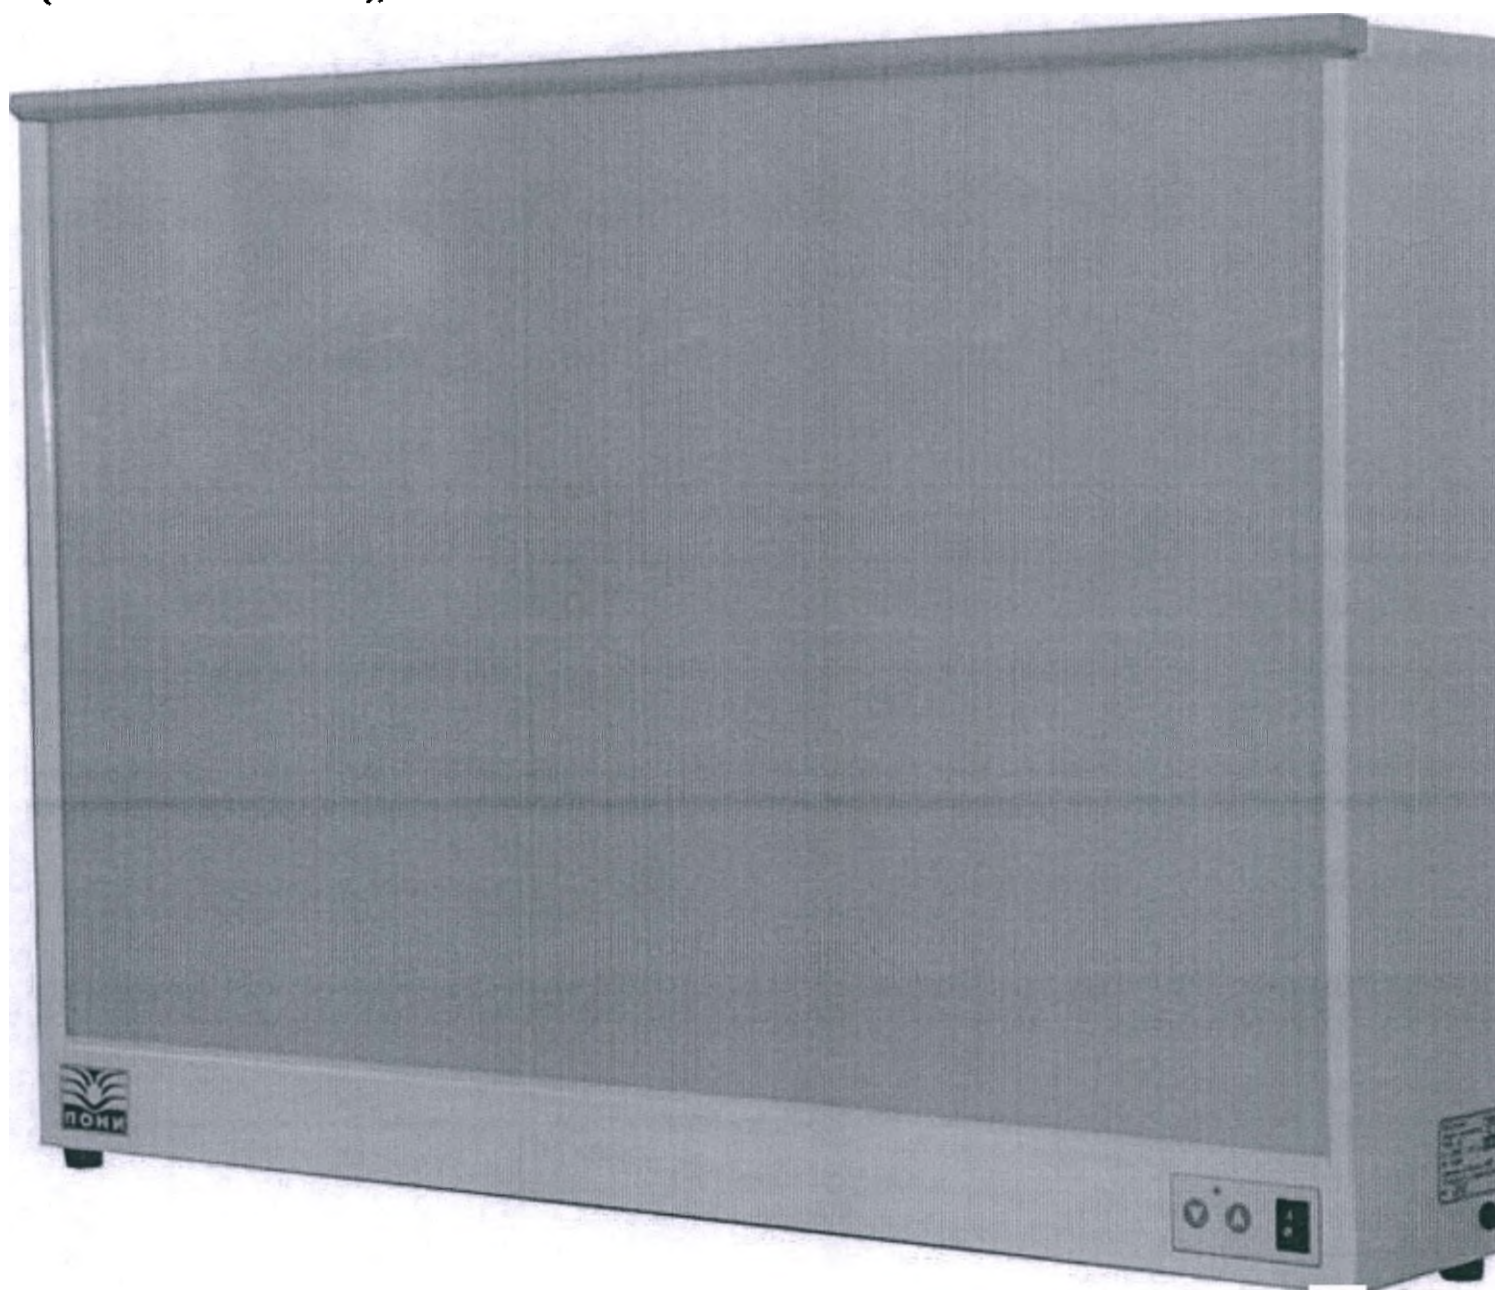

или негатоскоп «АРД» по ТУ 9452-001-35912766-2015 производства ООО «Витако» (РУ № РЗН 2016/4027);

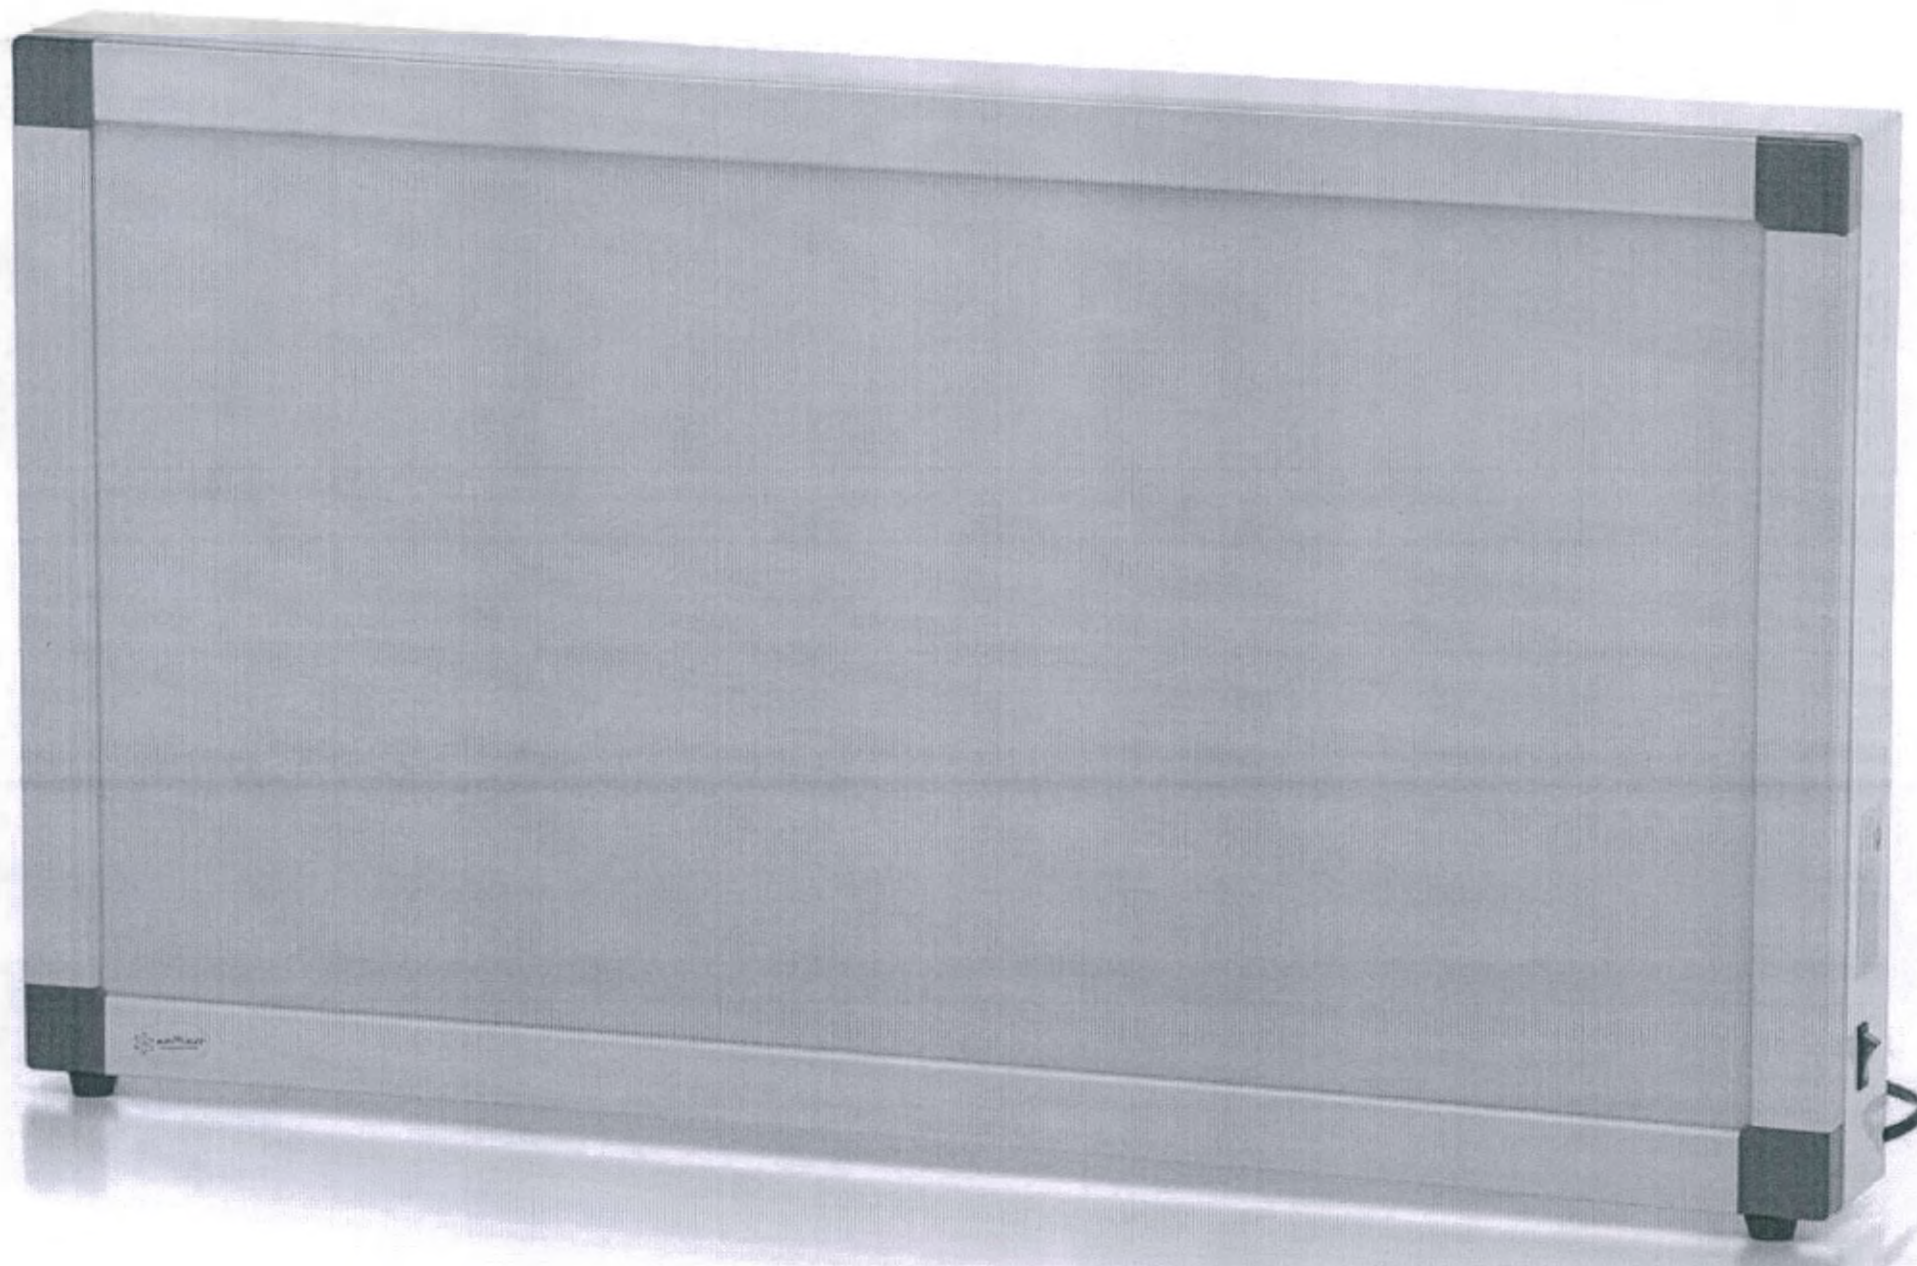


или негатоскоп медицинский серии Н по ТУ 9452-006-52132018-2015 производства ООО "Здоровый Мир" (РУ № РЗН 2016/4440);

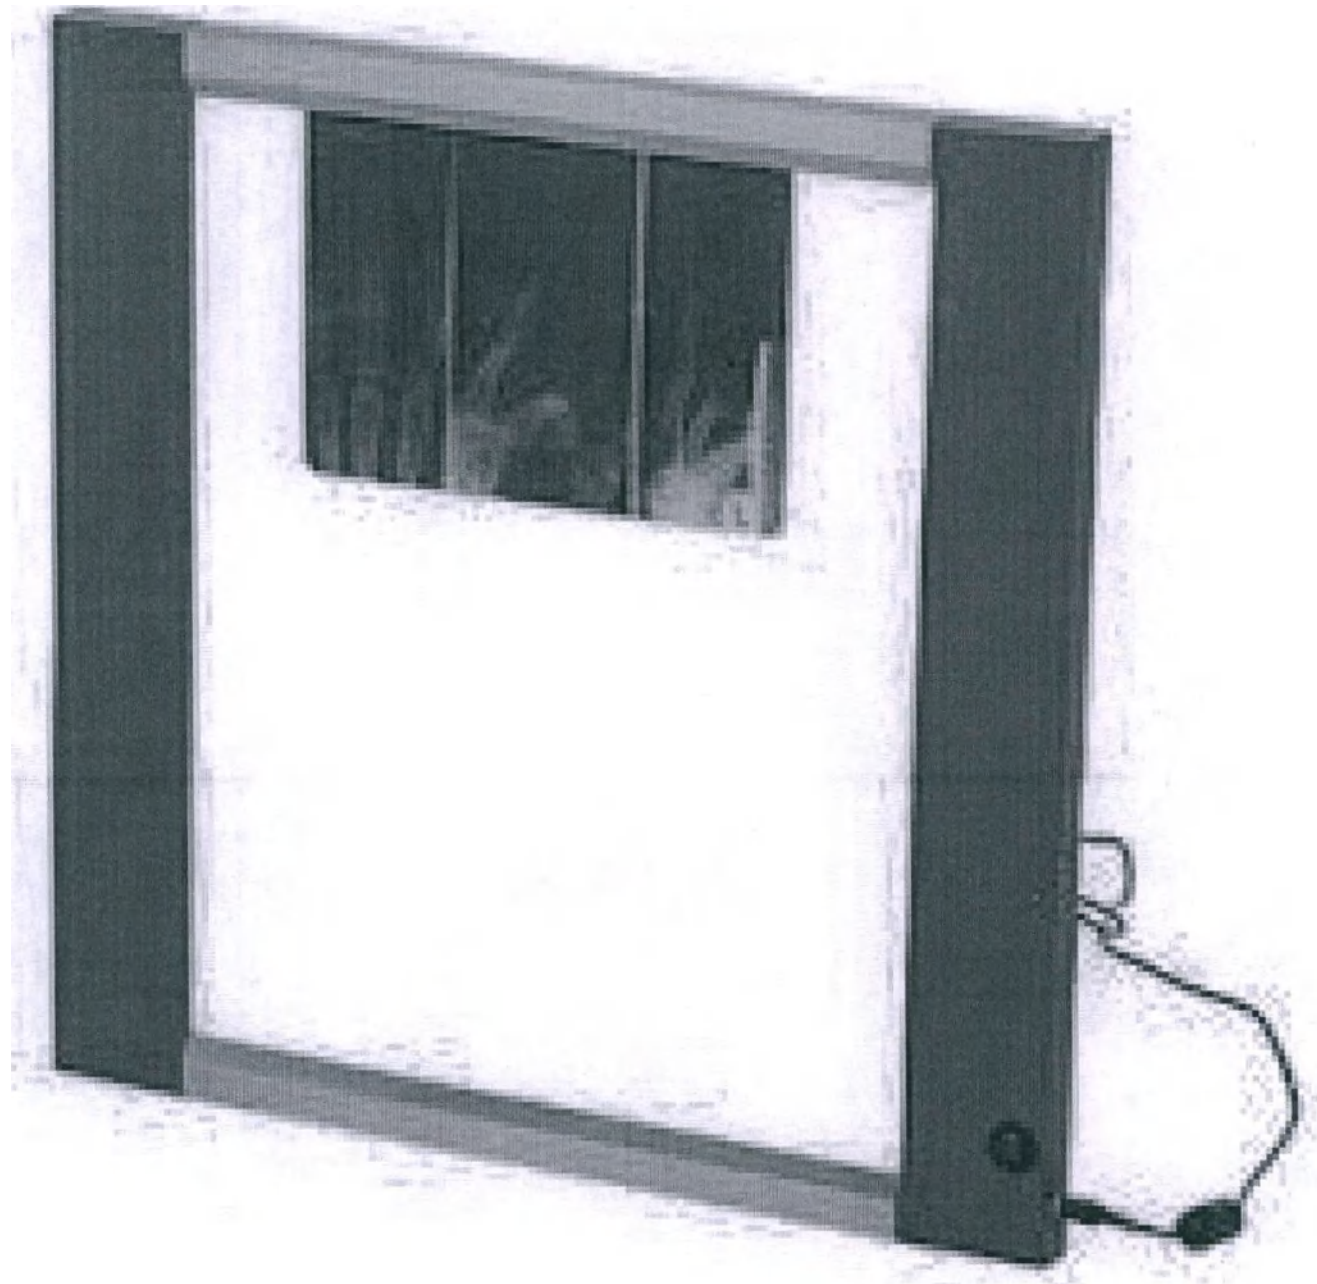


или негатоскопы медицинские НМ модификации: НМ-1, НМ-2, НМ-3 производства ООО «Мединдустрия Сервис» (РУ № РЗН 2013/1376).



25. Рентгенозащитное стекло/окно, эквивалент ослабления не менее 2,5 Pb «TISSA-RP» производства ООО «ТИССА», Республика Беларусь;

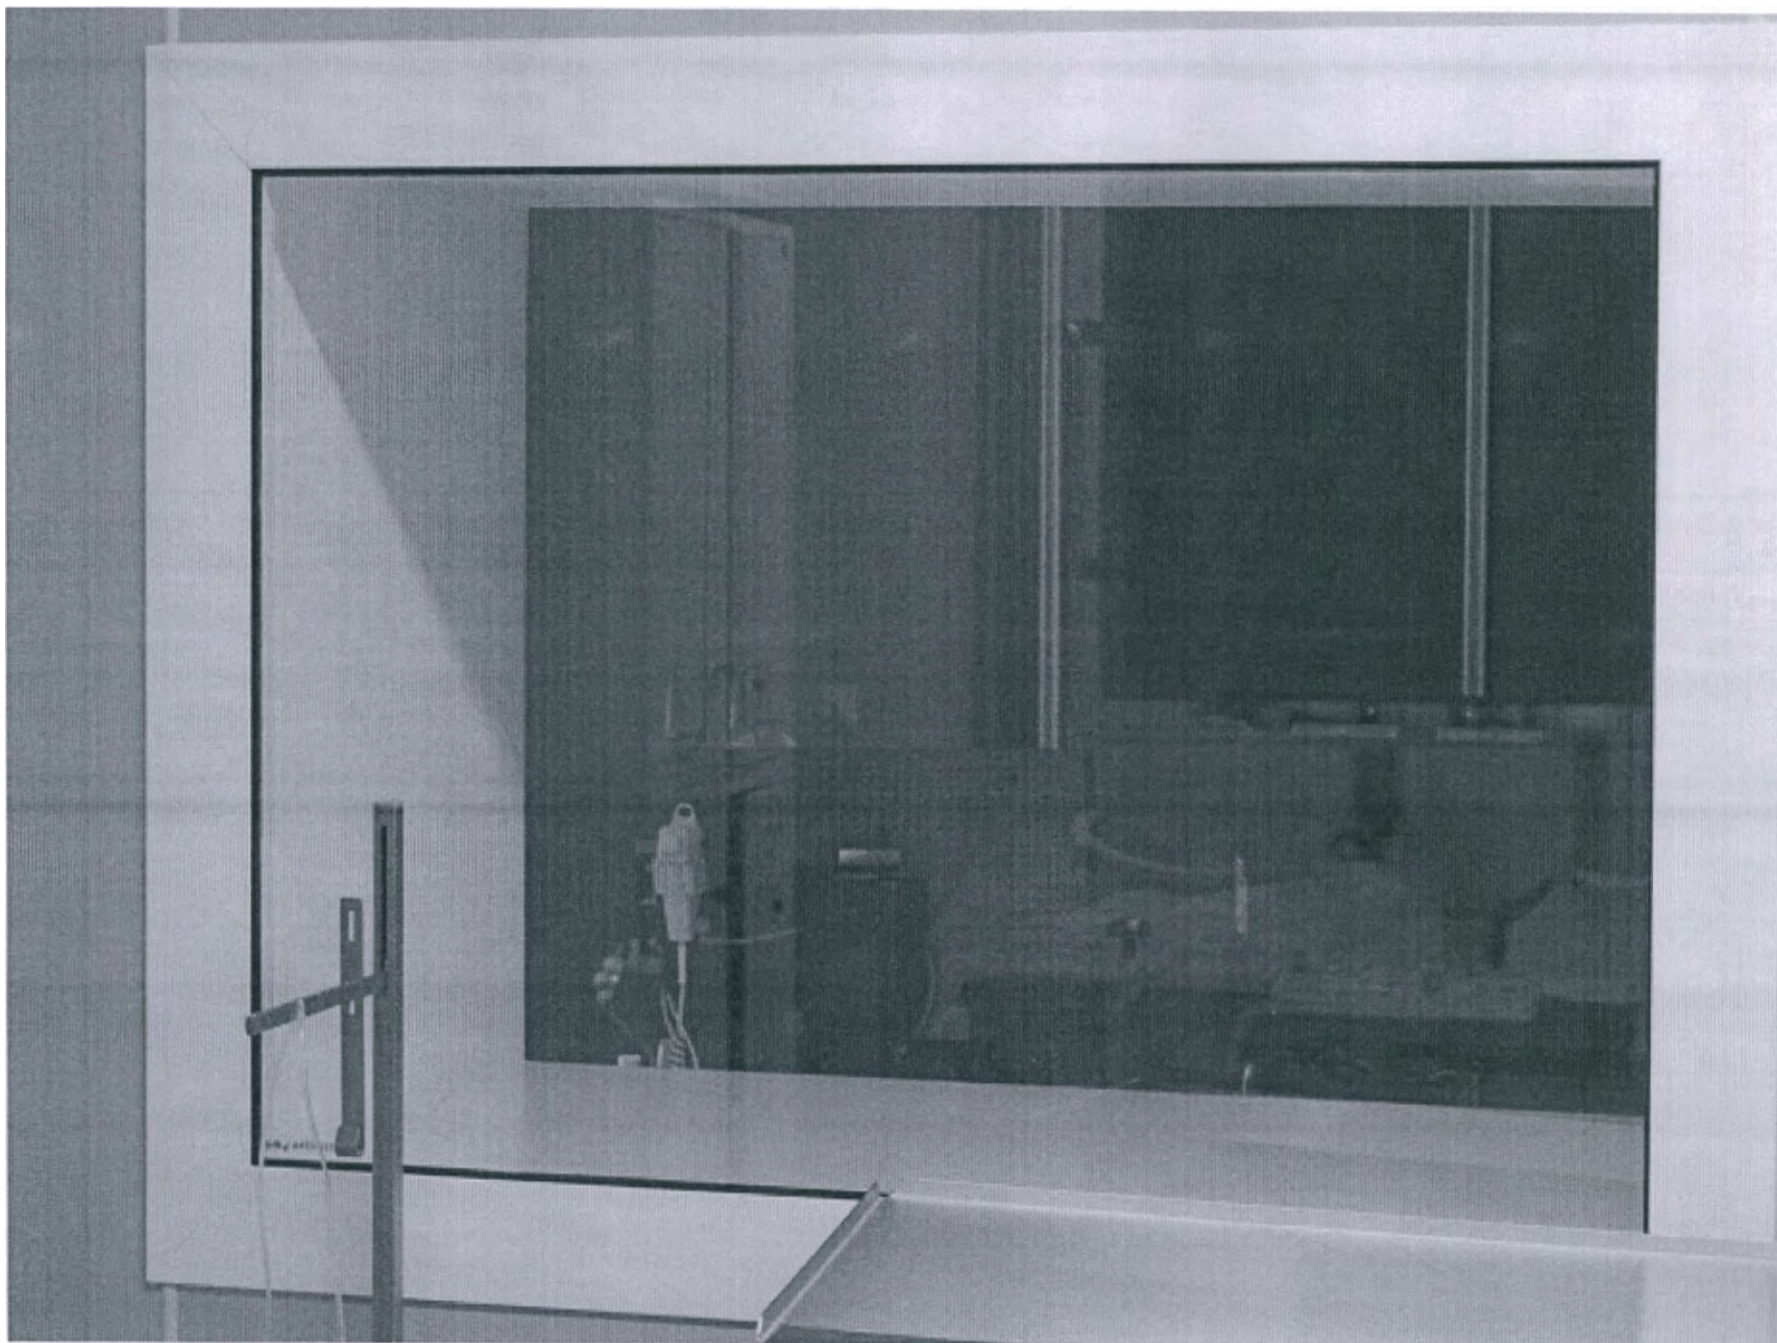



или РЕНЕКС ОСРЗ производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия.

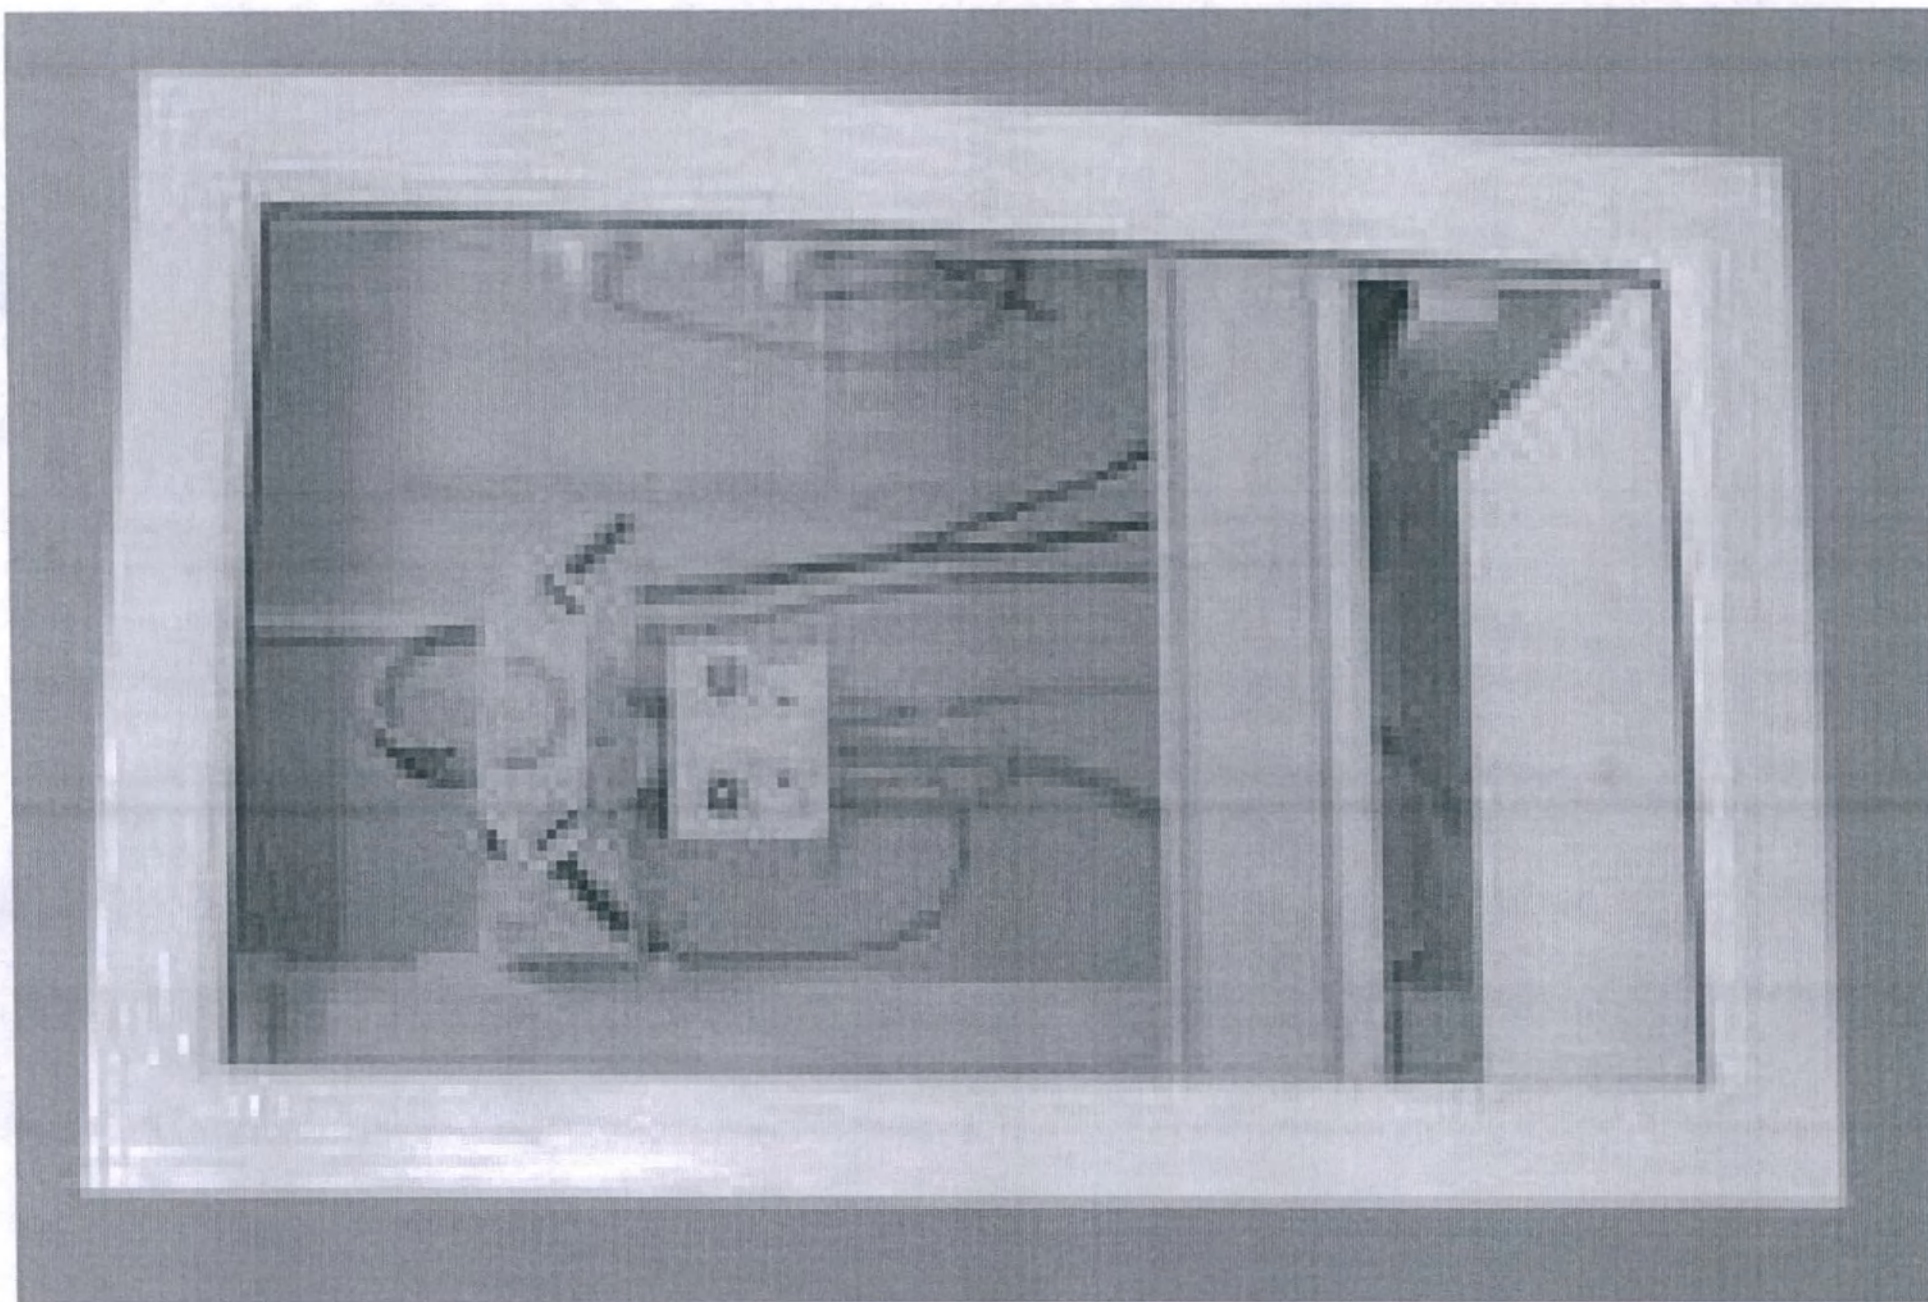

26. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-"РЕНЕКС" по ТУ 9398-010-21009821-2004 производства ЗАО «РЕНЕКС», Российская Федерация (РУ № ФСР 2008/03184);



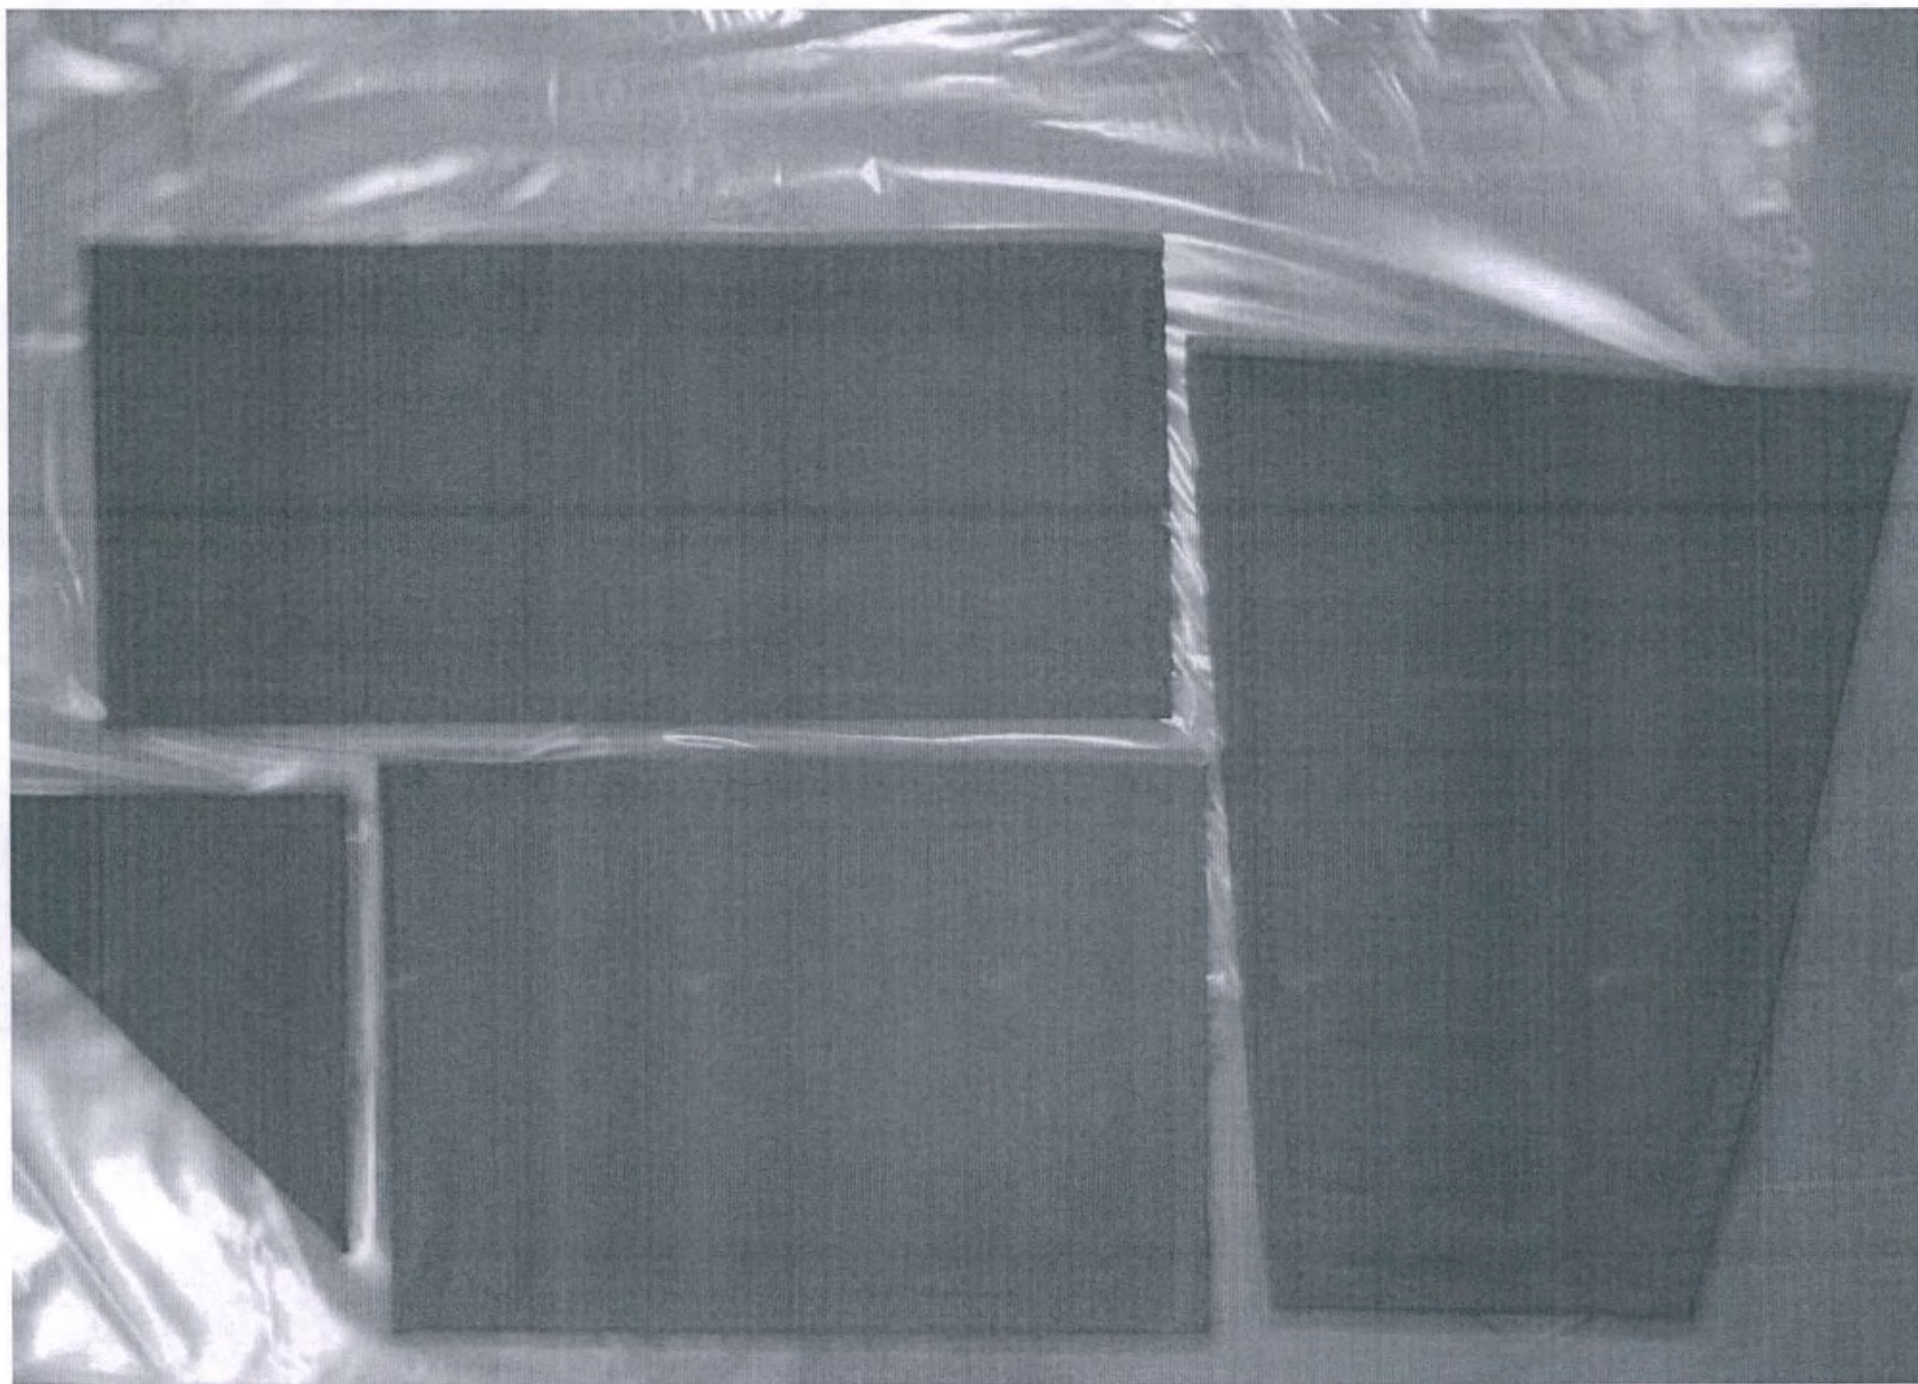

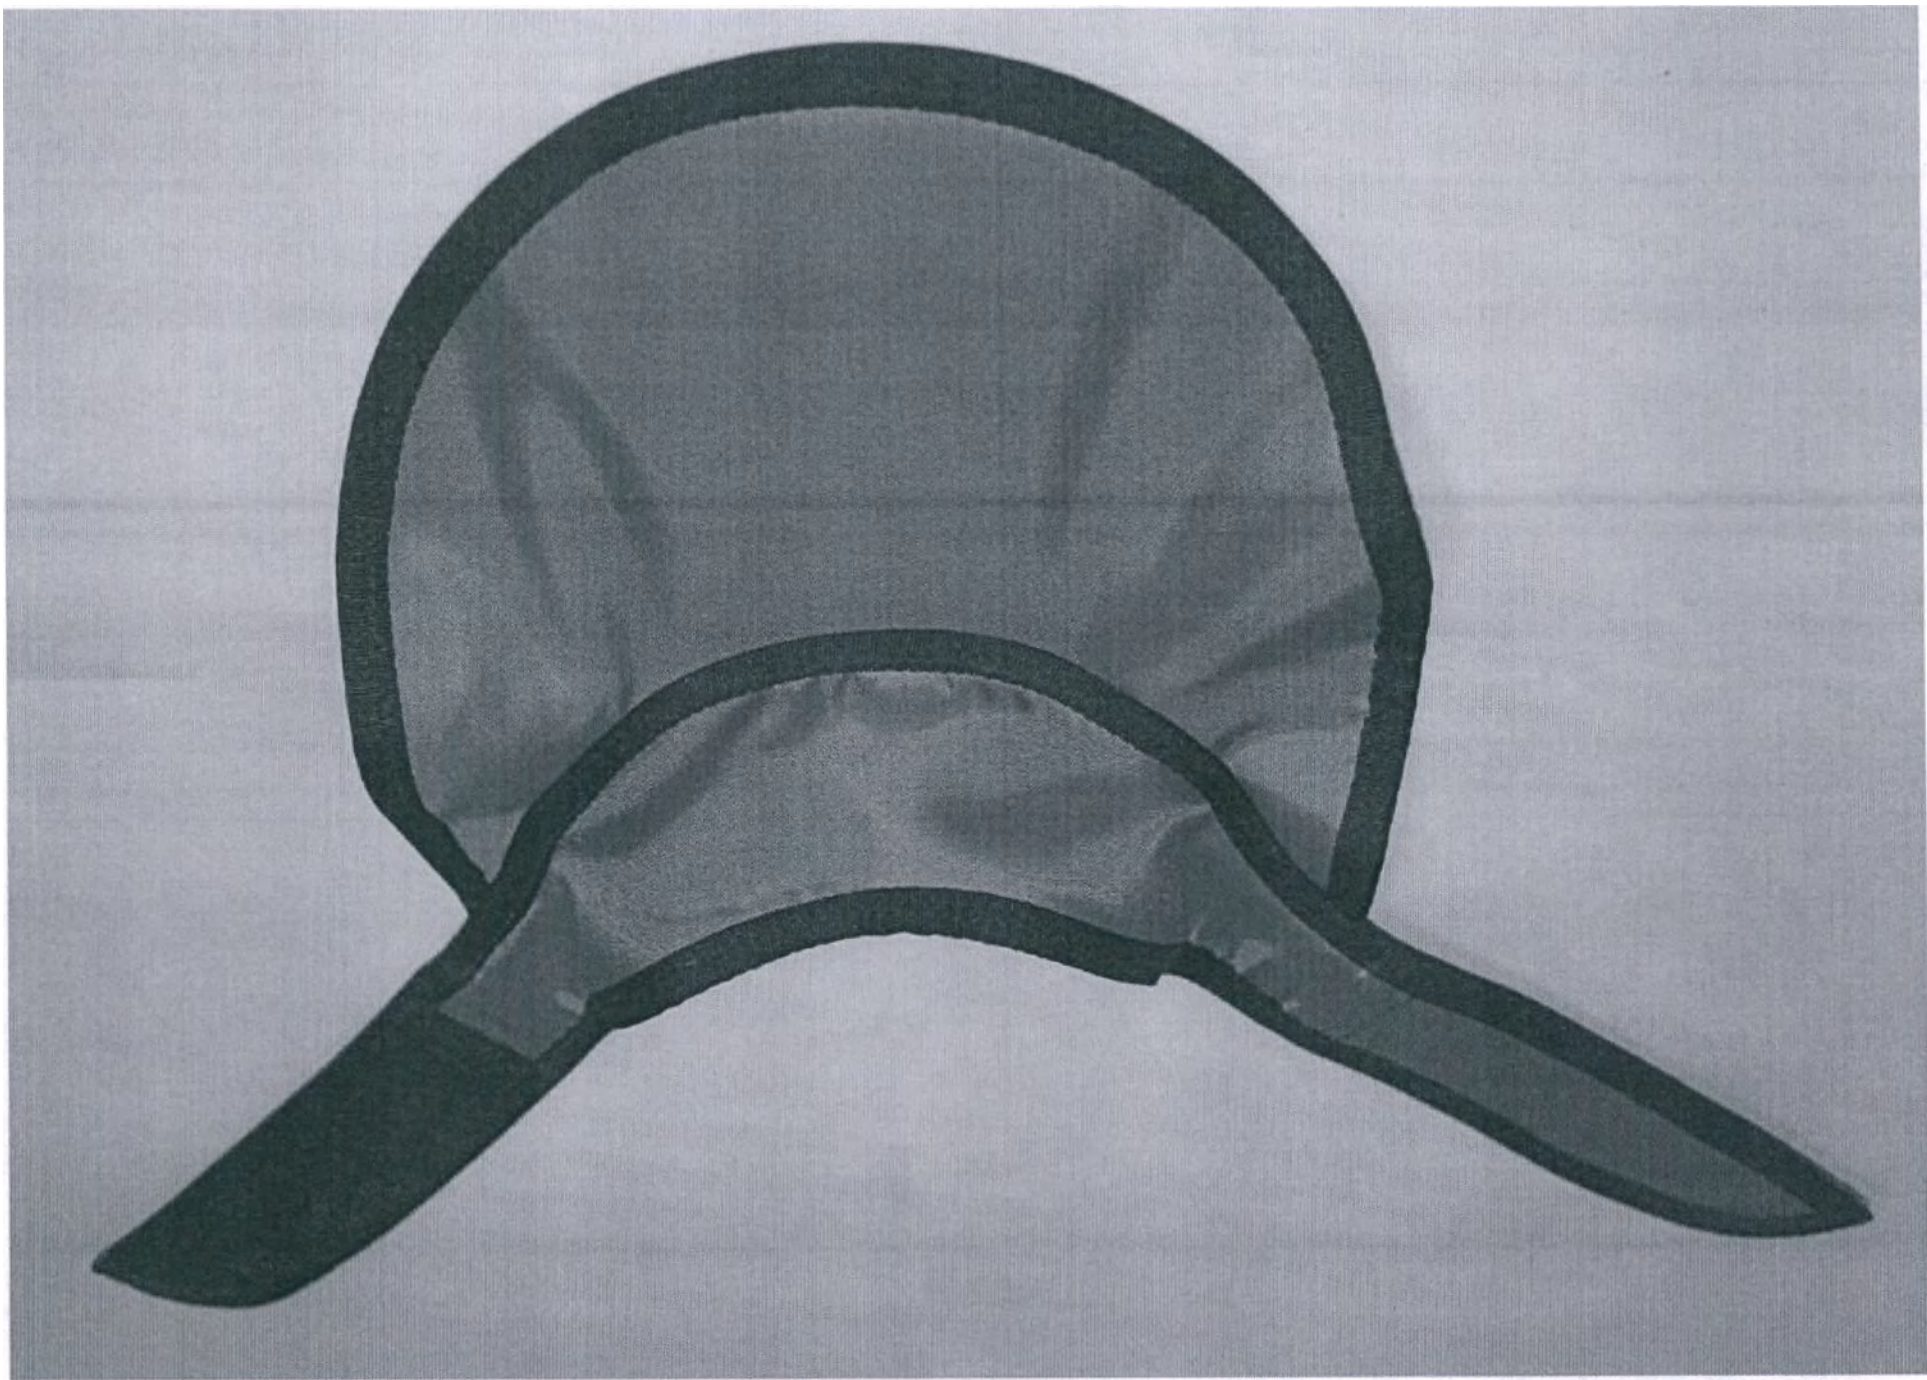



или комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006 производства ООО "МП НПФ «Гаммамед-П», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/10727);






или комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001 производства ООО «Рентген-Комплект», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/10477).

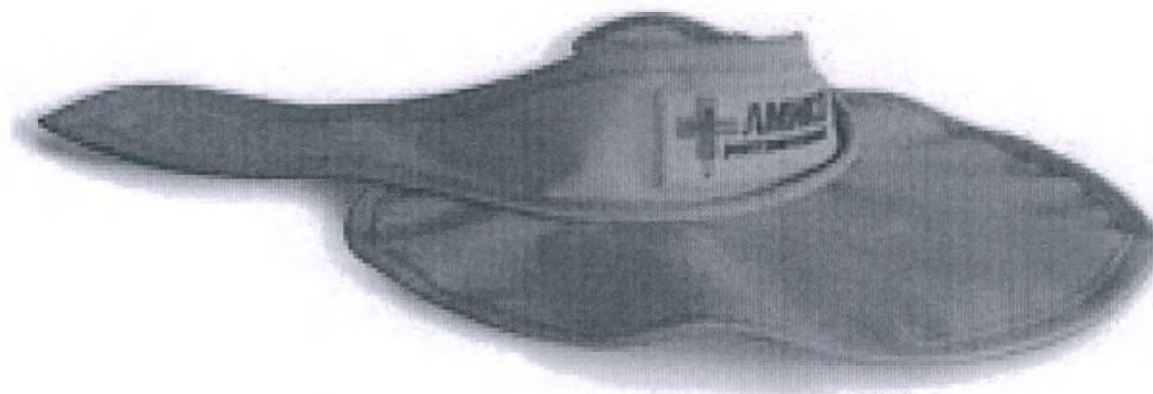


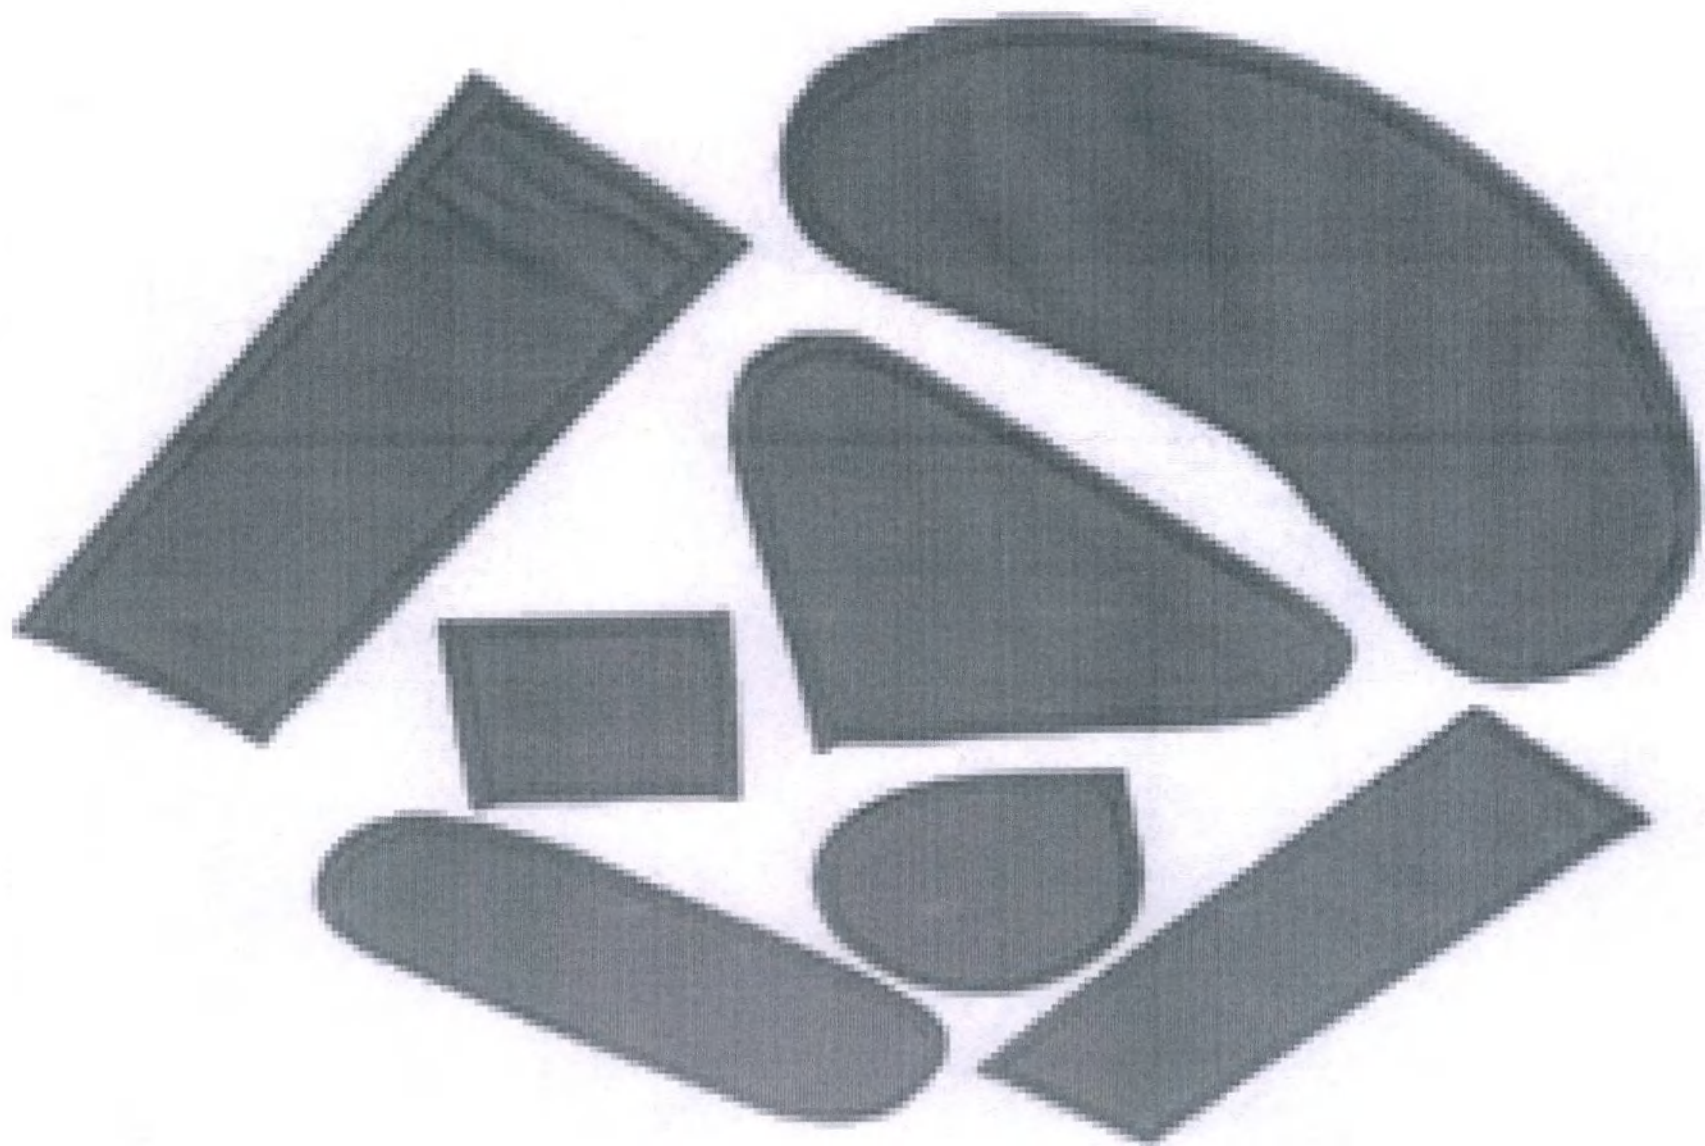

27. Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002 производства ЗАО «ПОНИ», Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/11811);

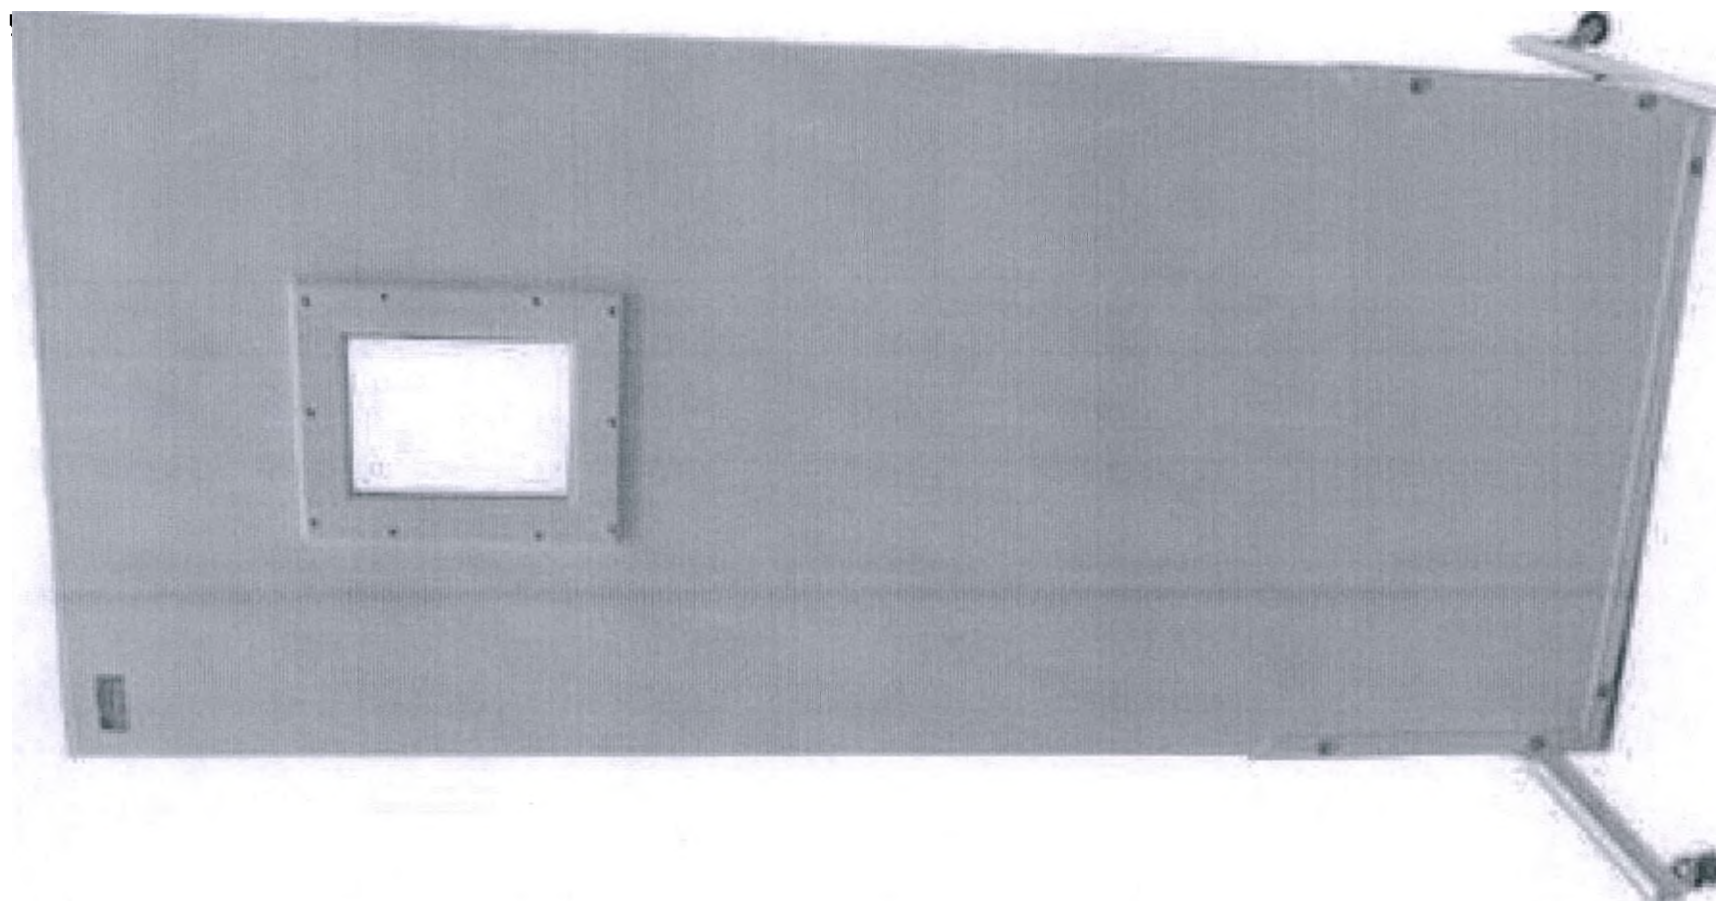


или ширмы рентгенозащитные резиносвинцовые передвижные по ТУ 9452-010-46782692-2001 производства «Рентген-Комплект», Российская Федерация (ПУ № ФСР 2011/10476).

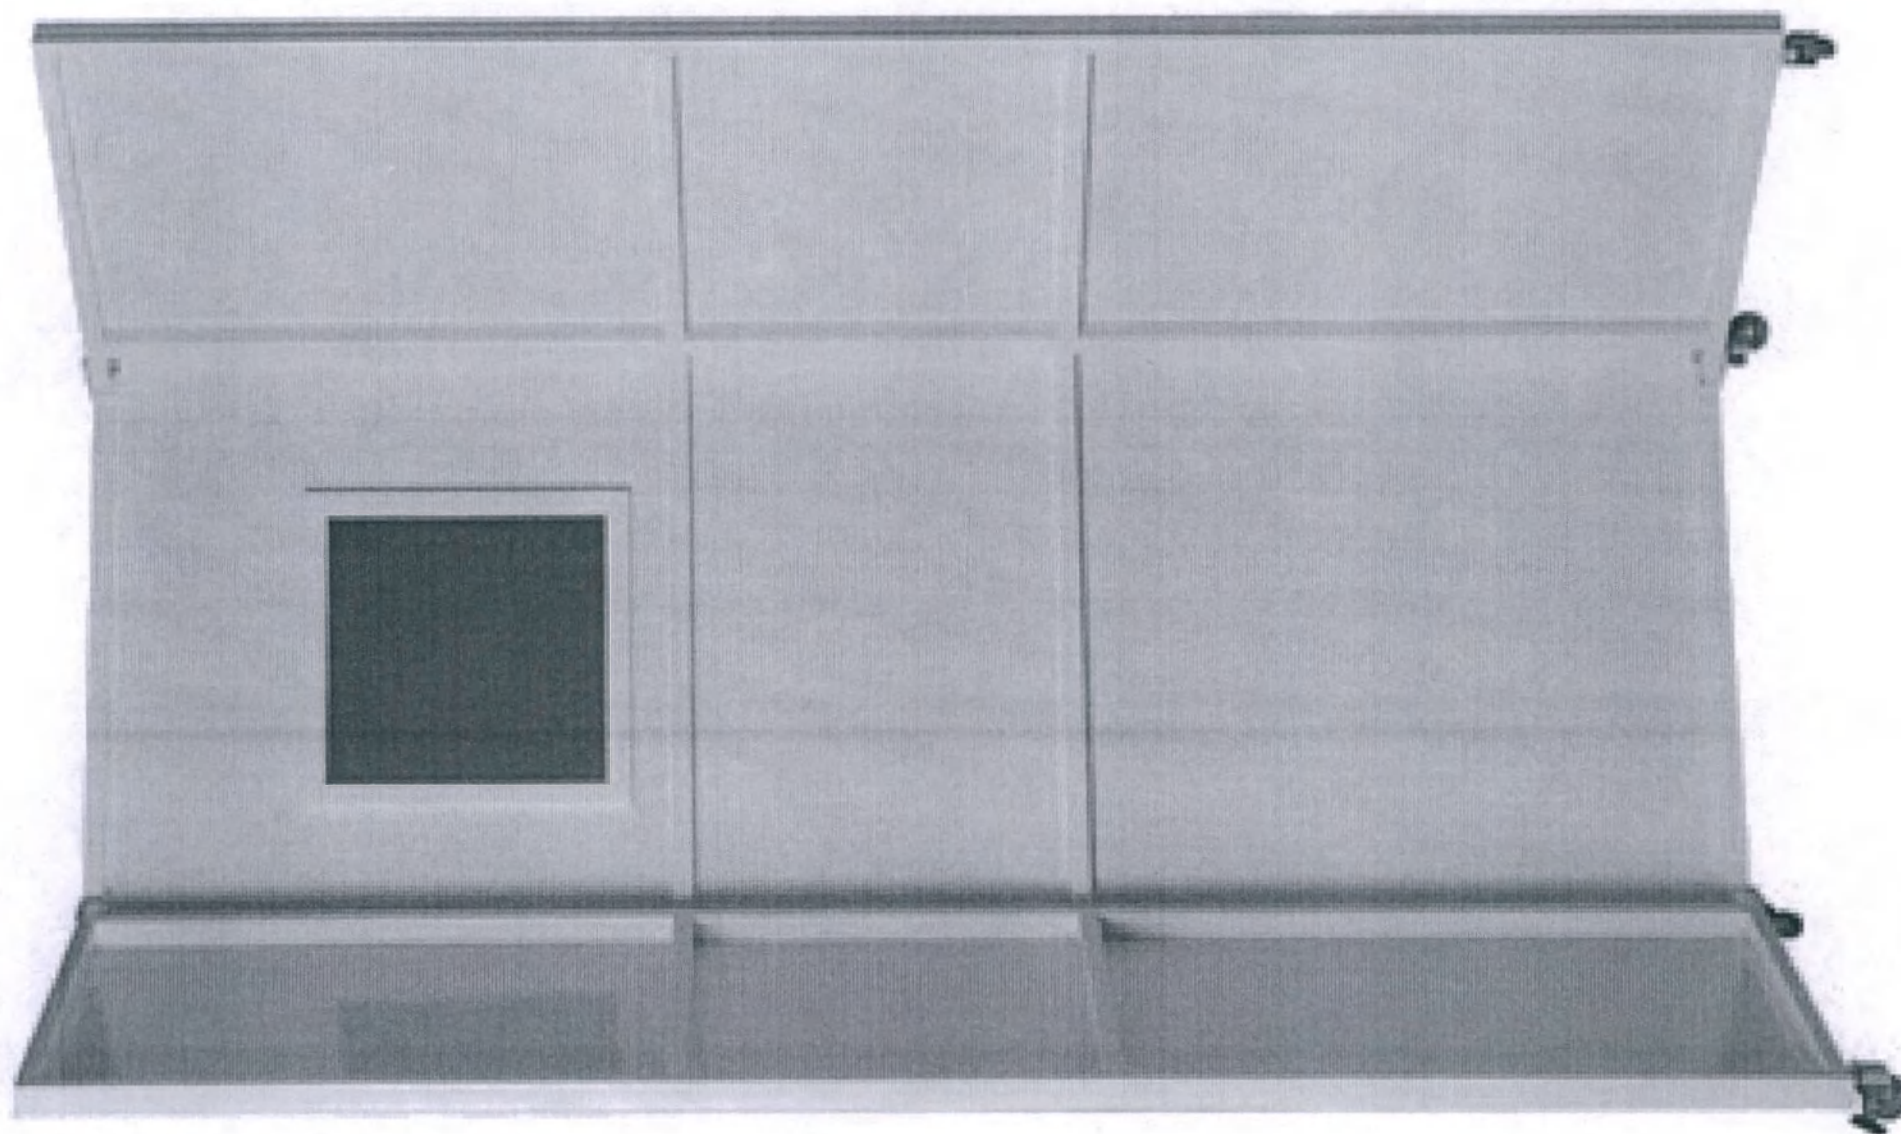


28. Стол для пациента мобильный производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори».




29. Люлька детская двойного поворота передвижная для полипозиционных исследований ЛДДП-1 по ТУ 9442-027-11396834-2006 производства ООО «СпектрАп», Российская Федерация (РУ № ФСР 2010/09430).

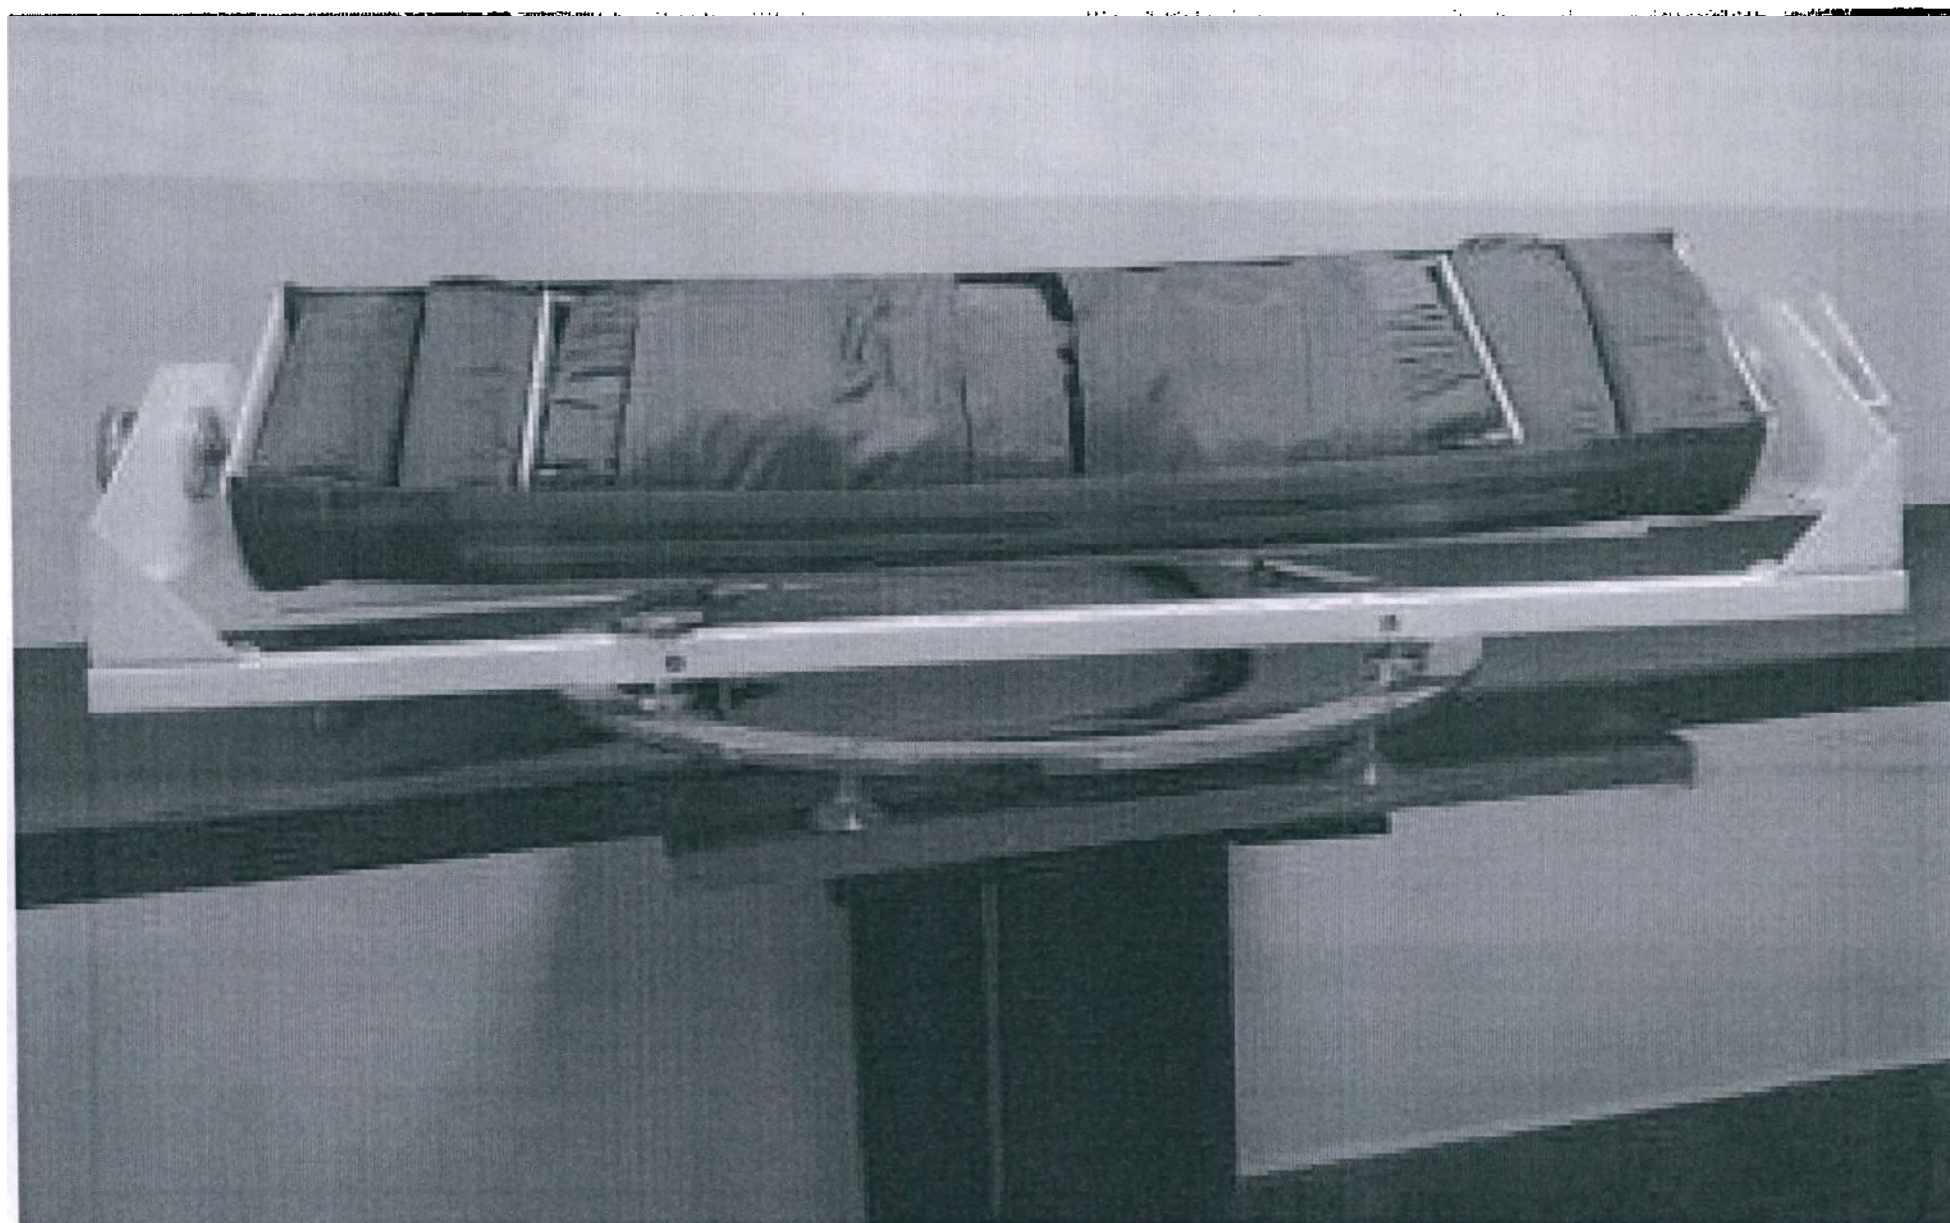

30. Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-800020198-2010 производства ИП Давлетов Д.Я., Российская Федерация (РУ № ФСР 2011/09994);

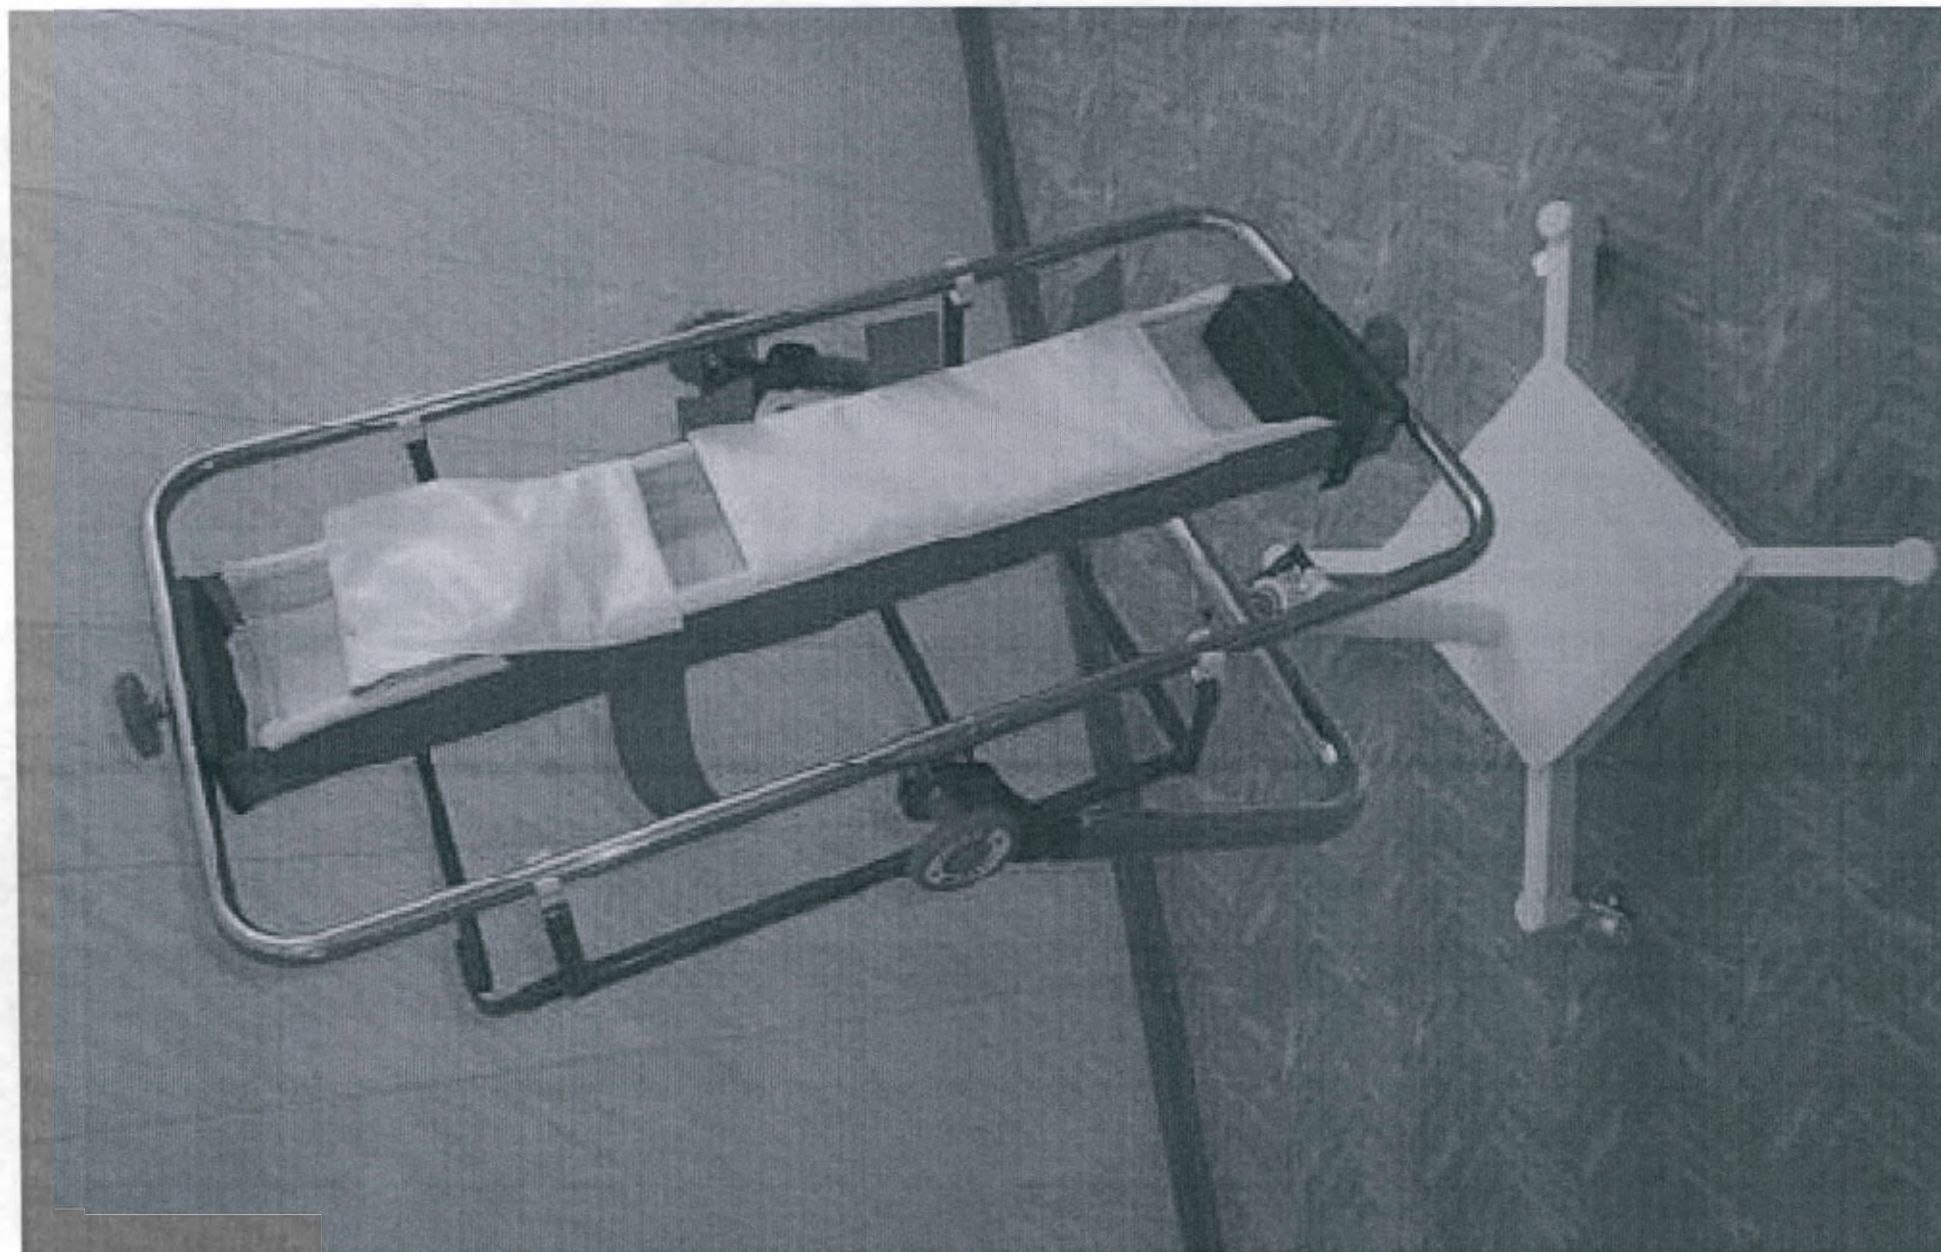


или устройство для позиционирования детей Octopaque или Minipaque или Octoroll производства фирмы Oktostop inc. Канада;

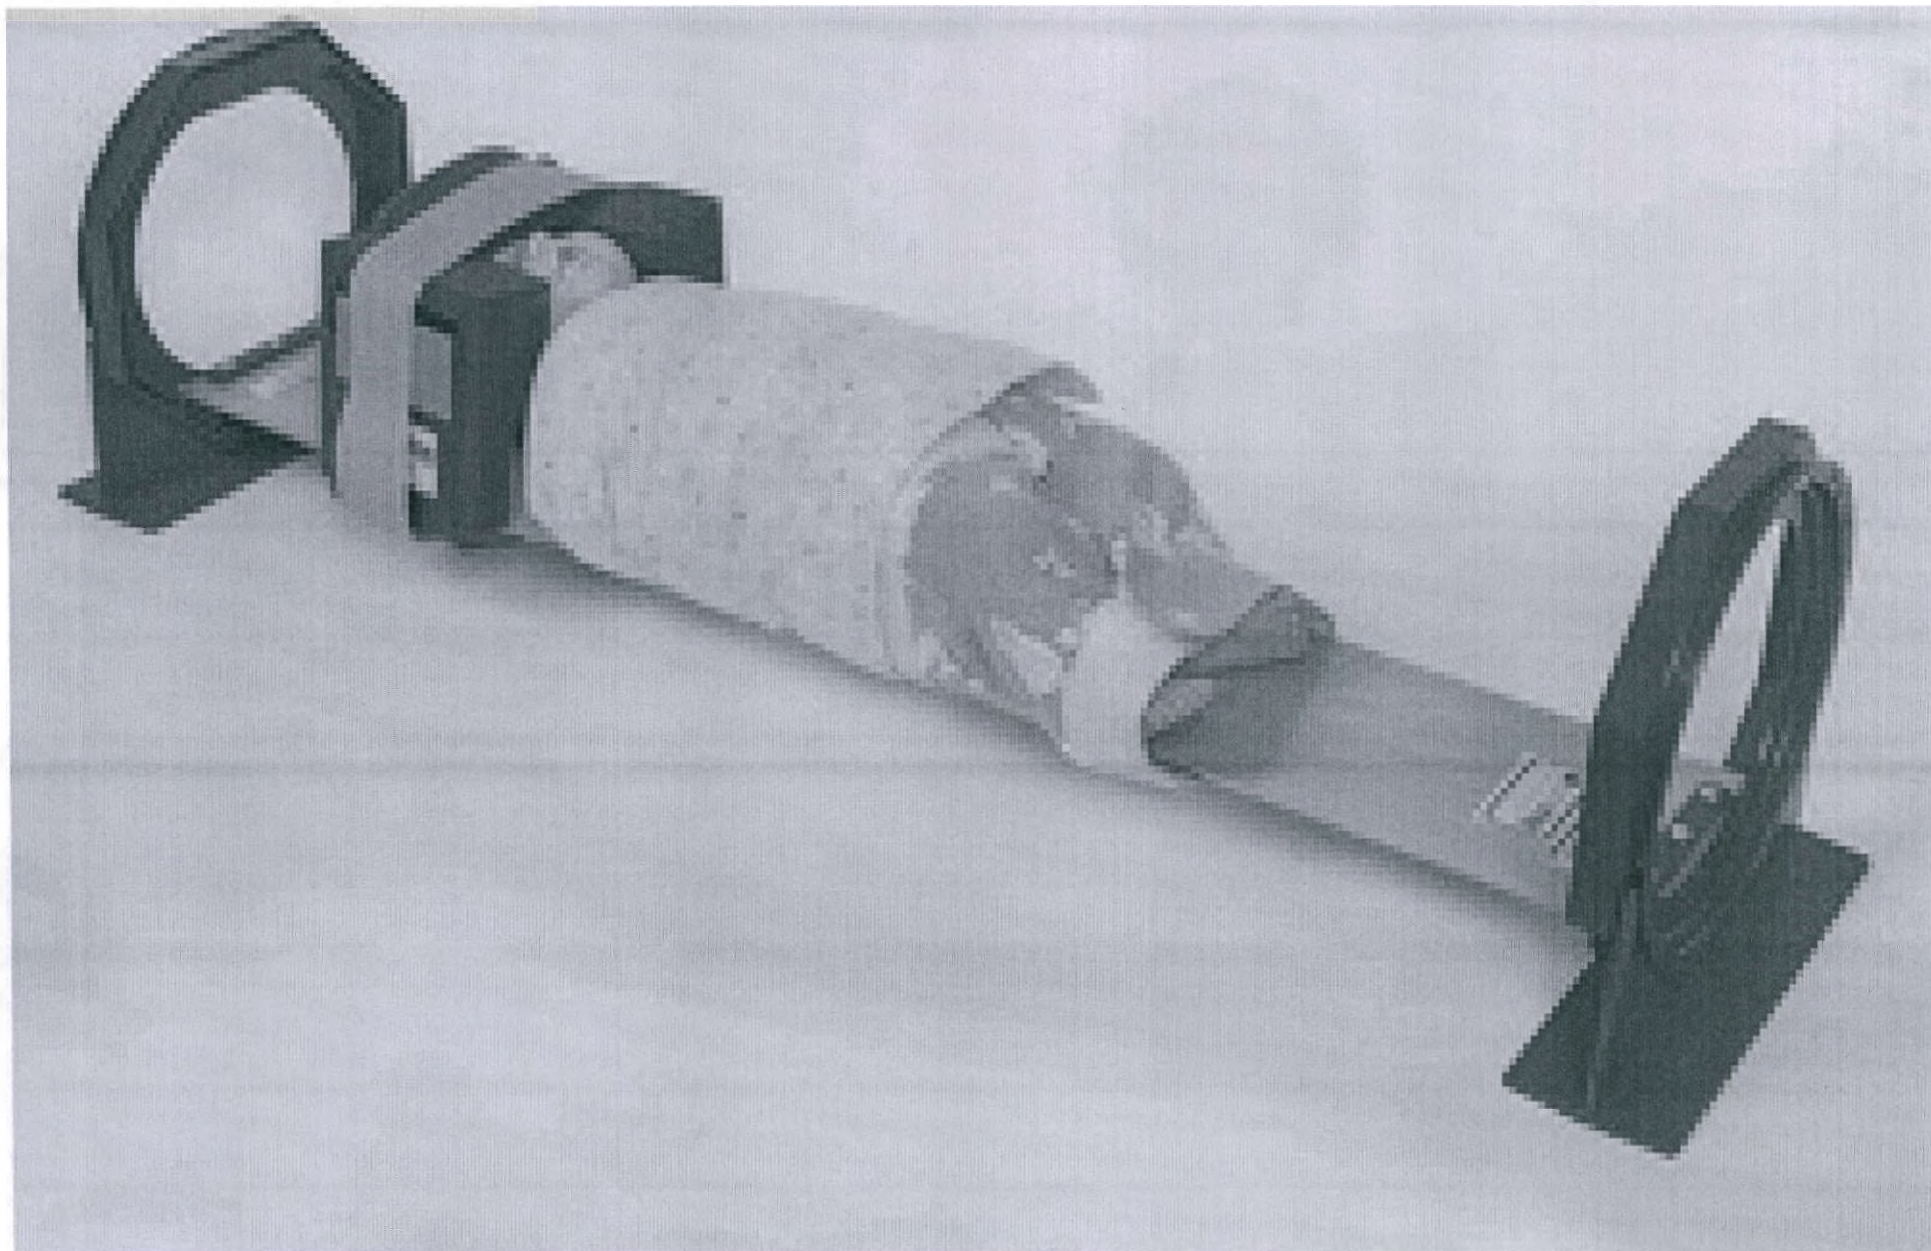


или «РЕНЕКС УРИД» производства фирмы ЗАО "РЕНЕКС", Российская Федерация; или производства ООО «С.П. Гелпик», Российская Федерация.





31. Машина для проявления медицинских рентгеновских пленок SRX-101A производства Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., Япония (РУ № РЗН 2013/1252).

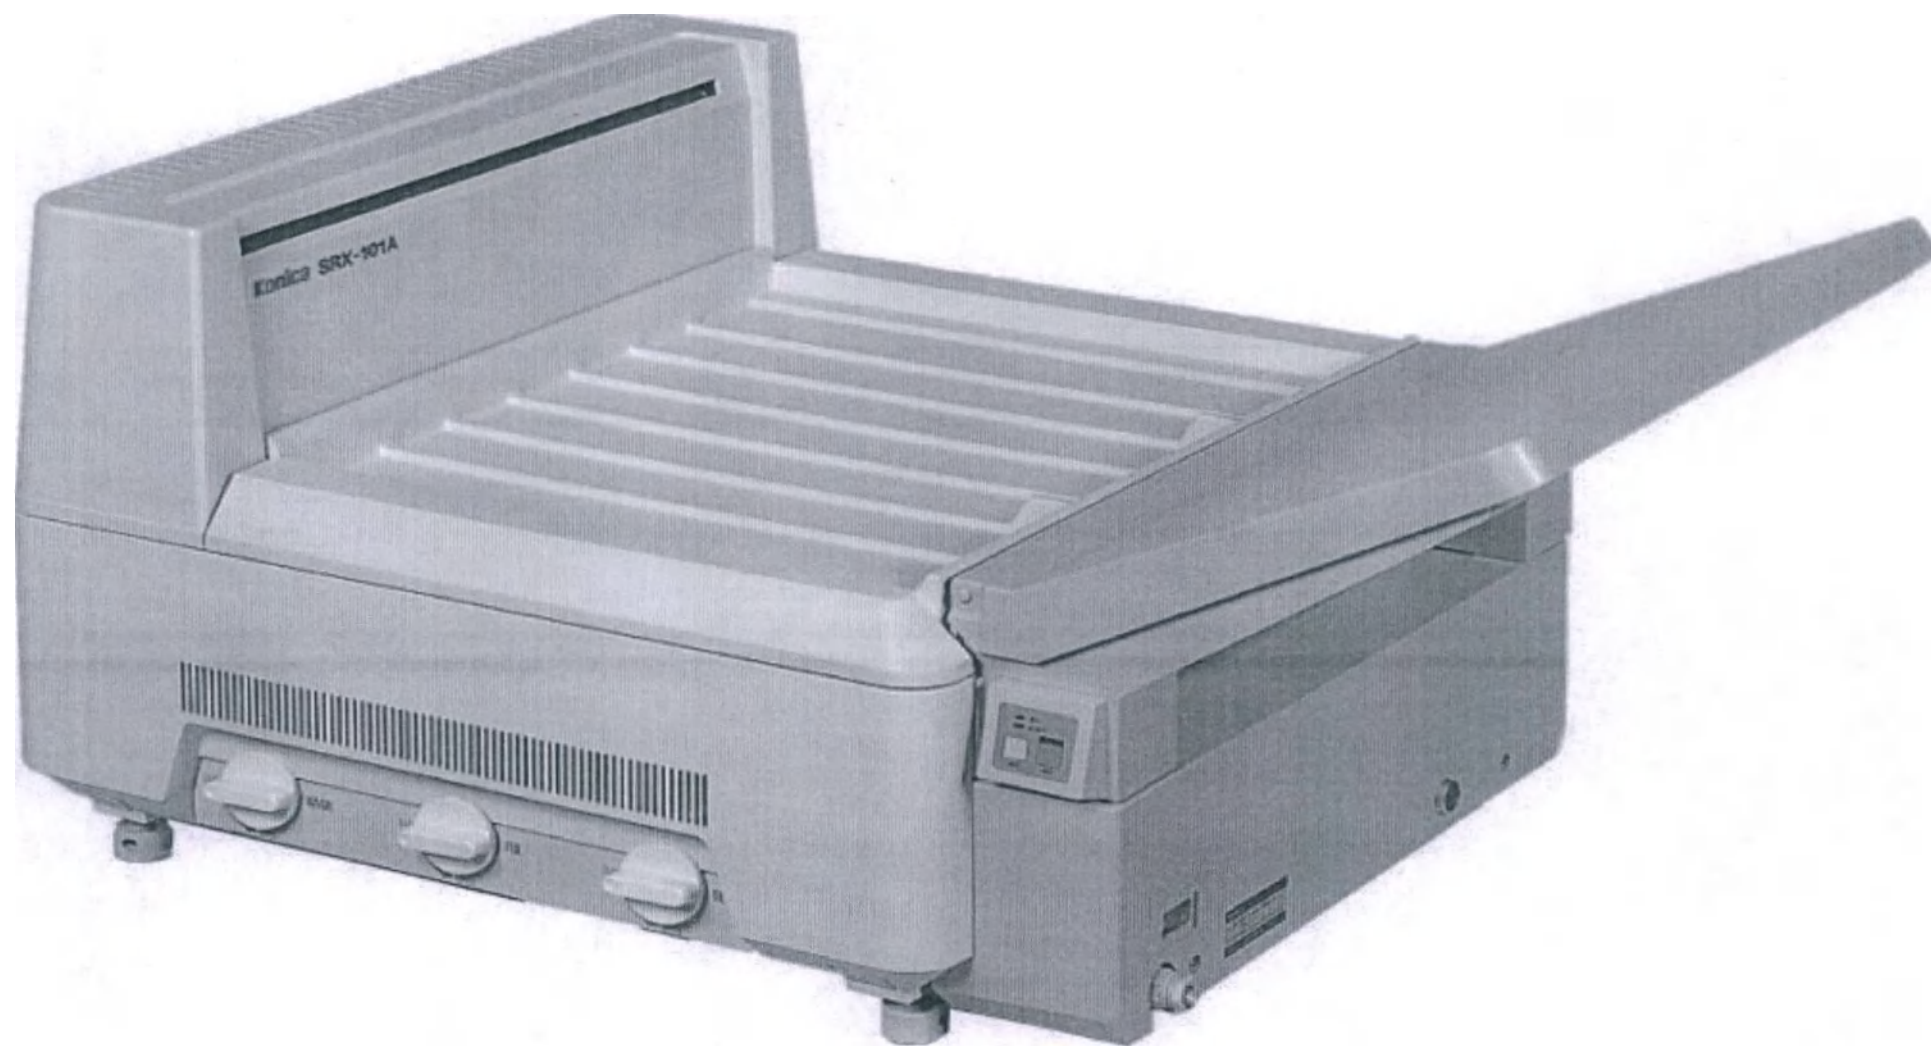



Упаковка

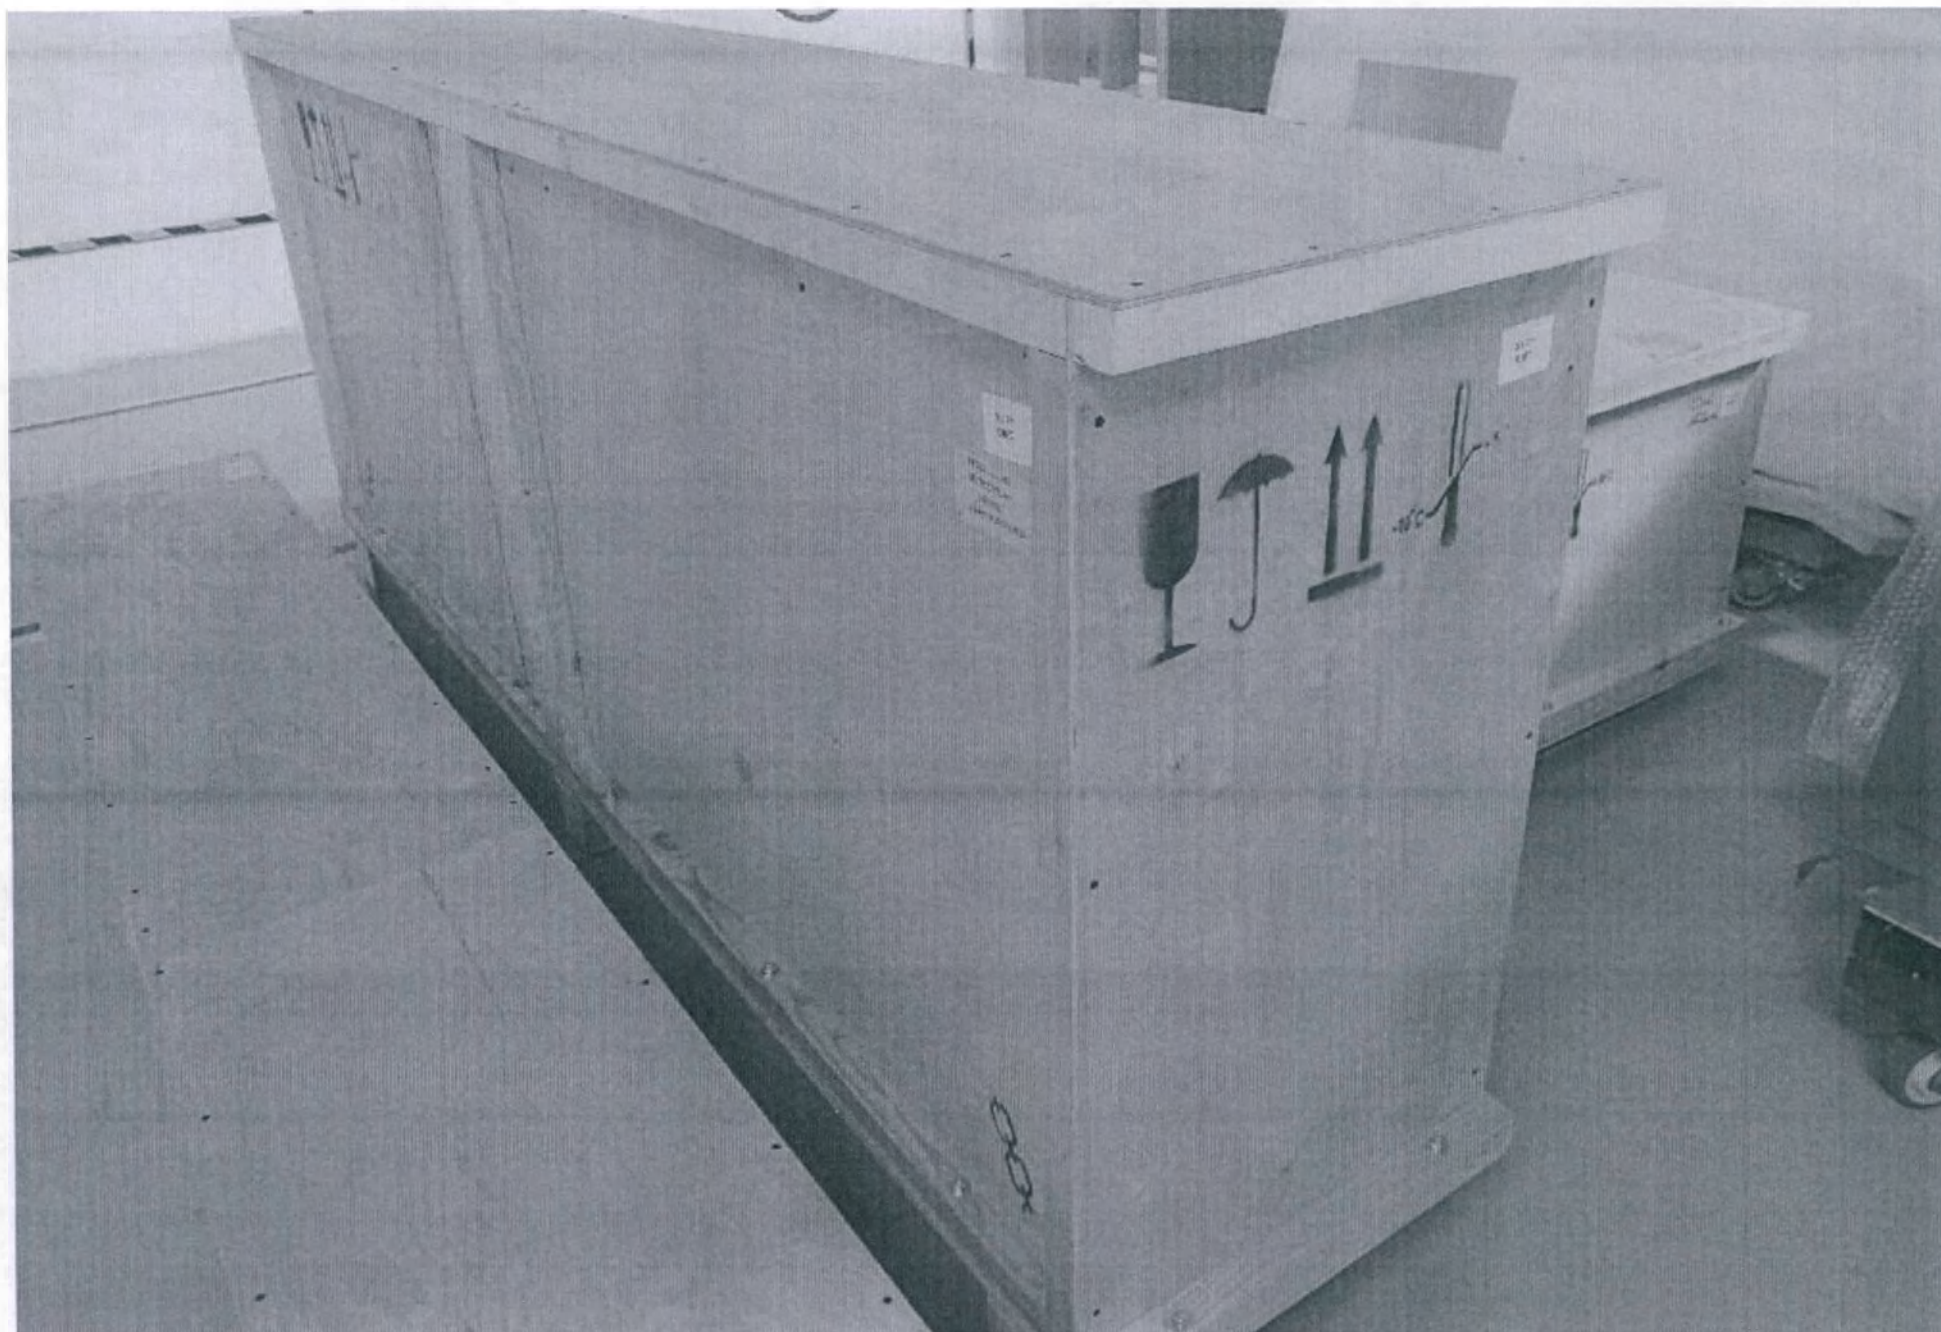

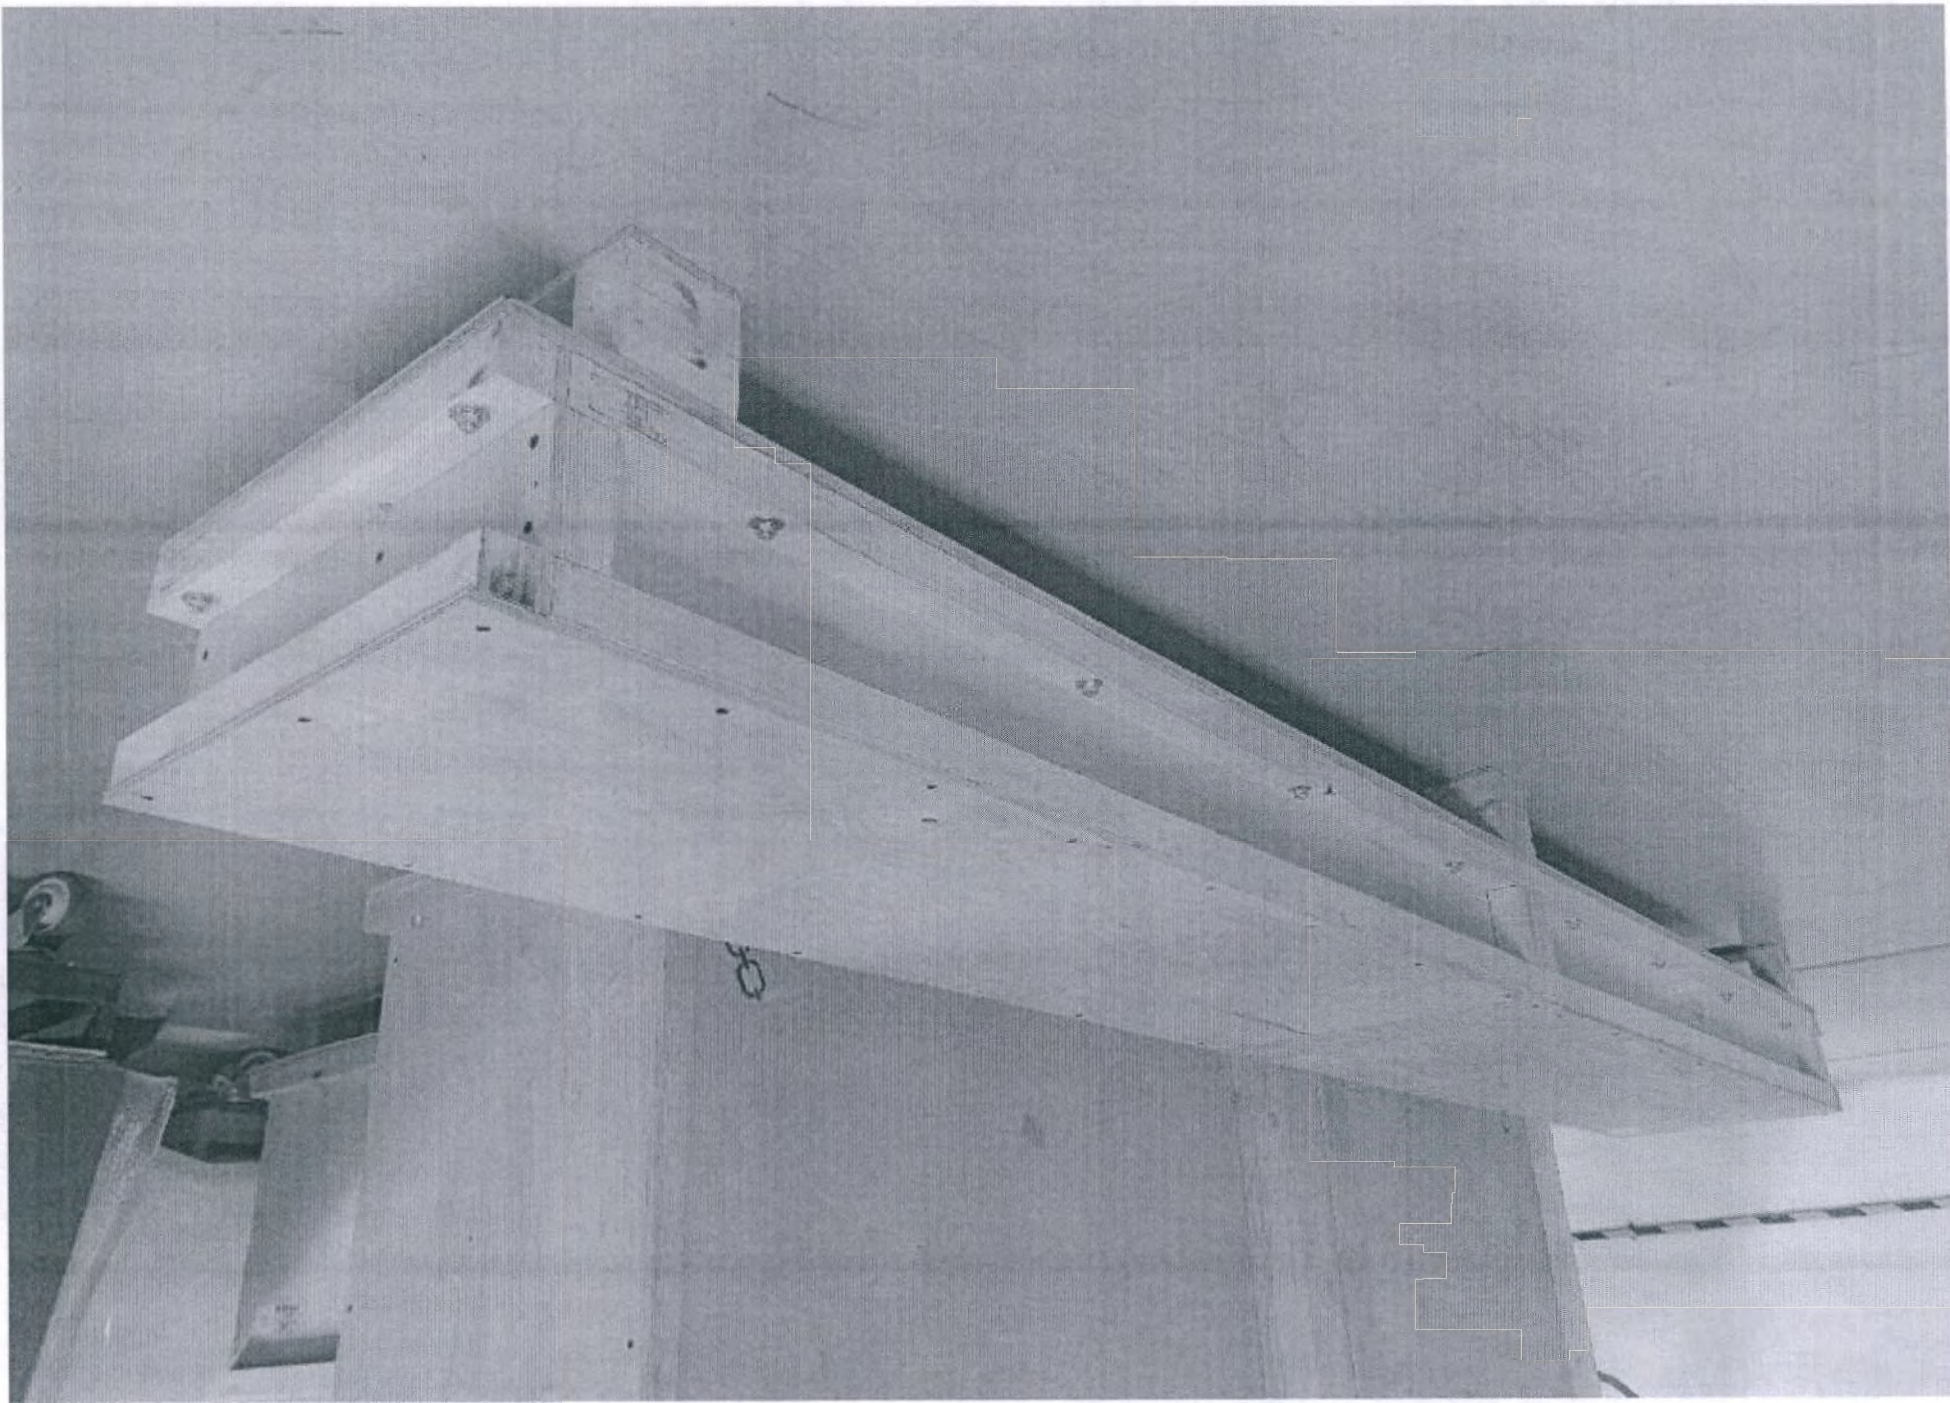


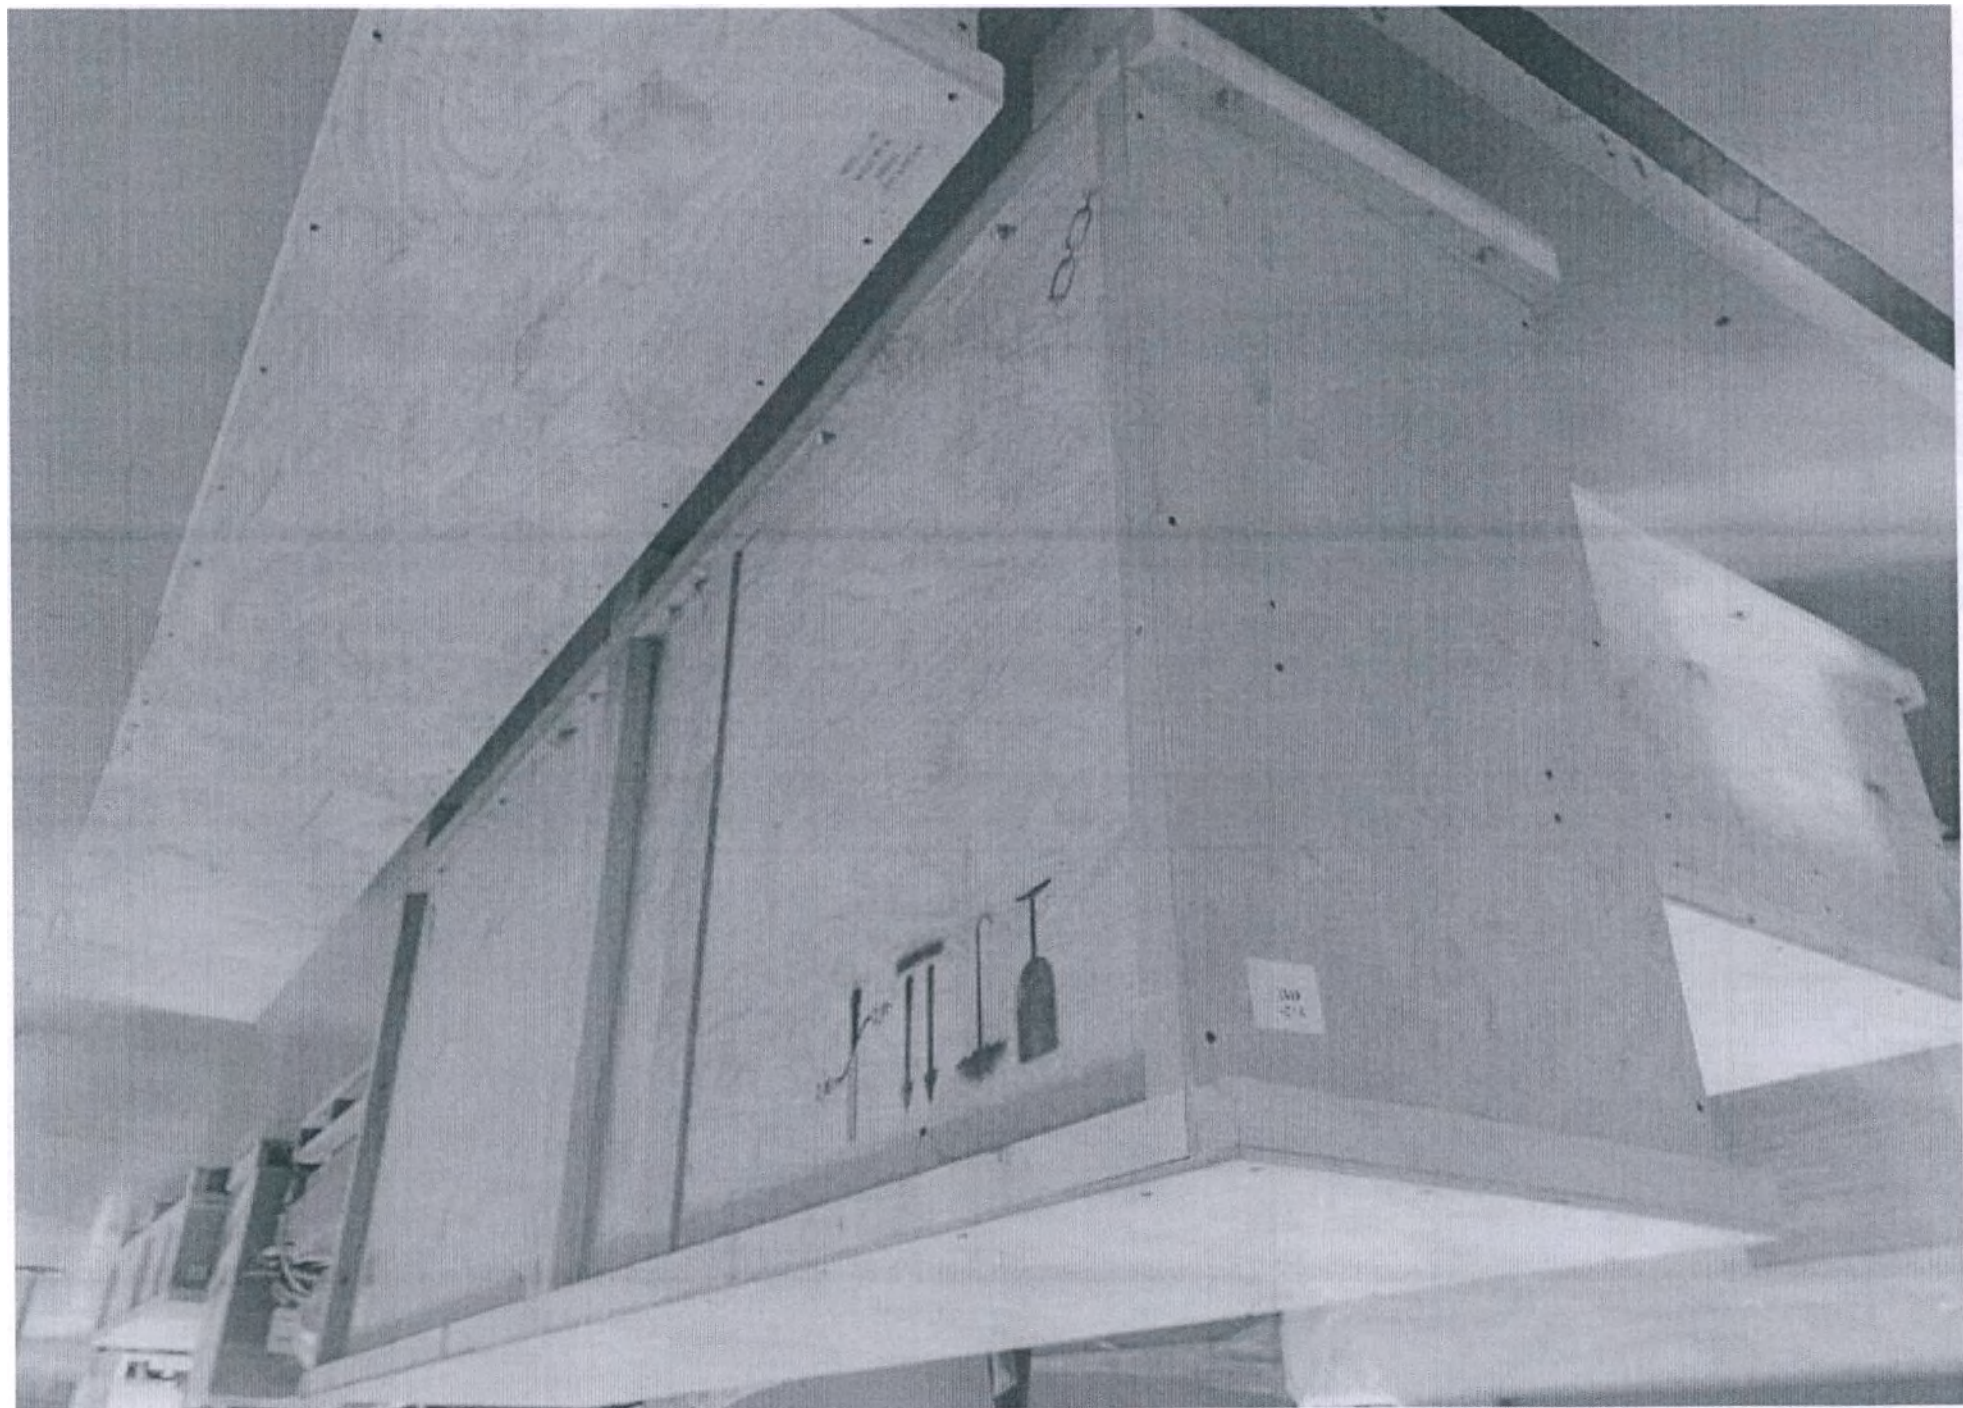


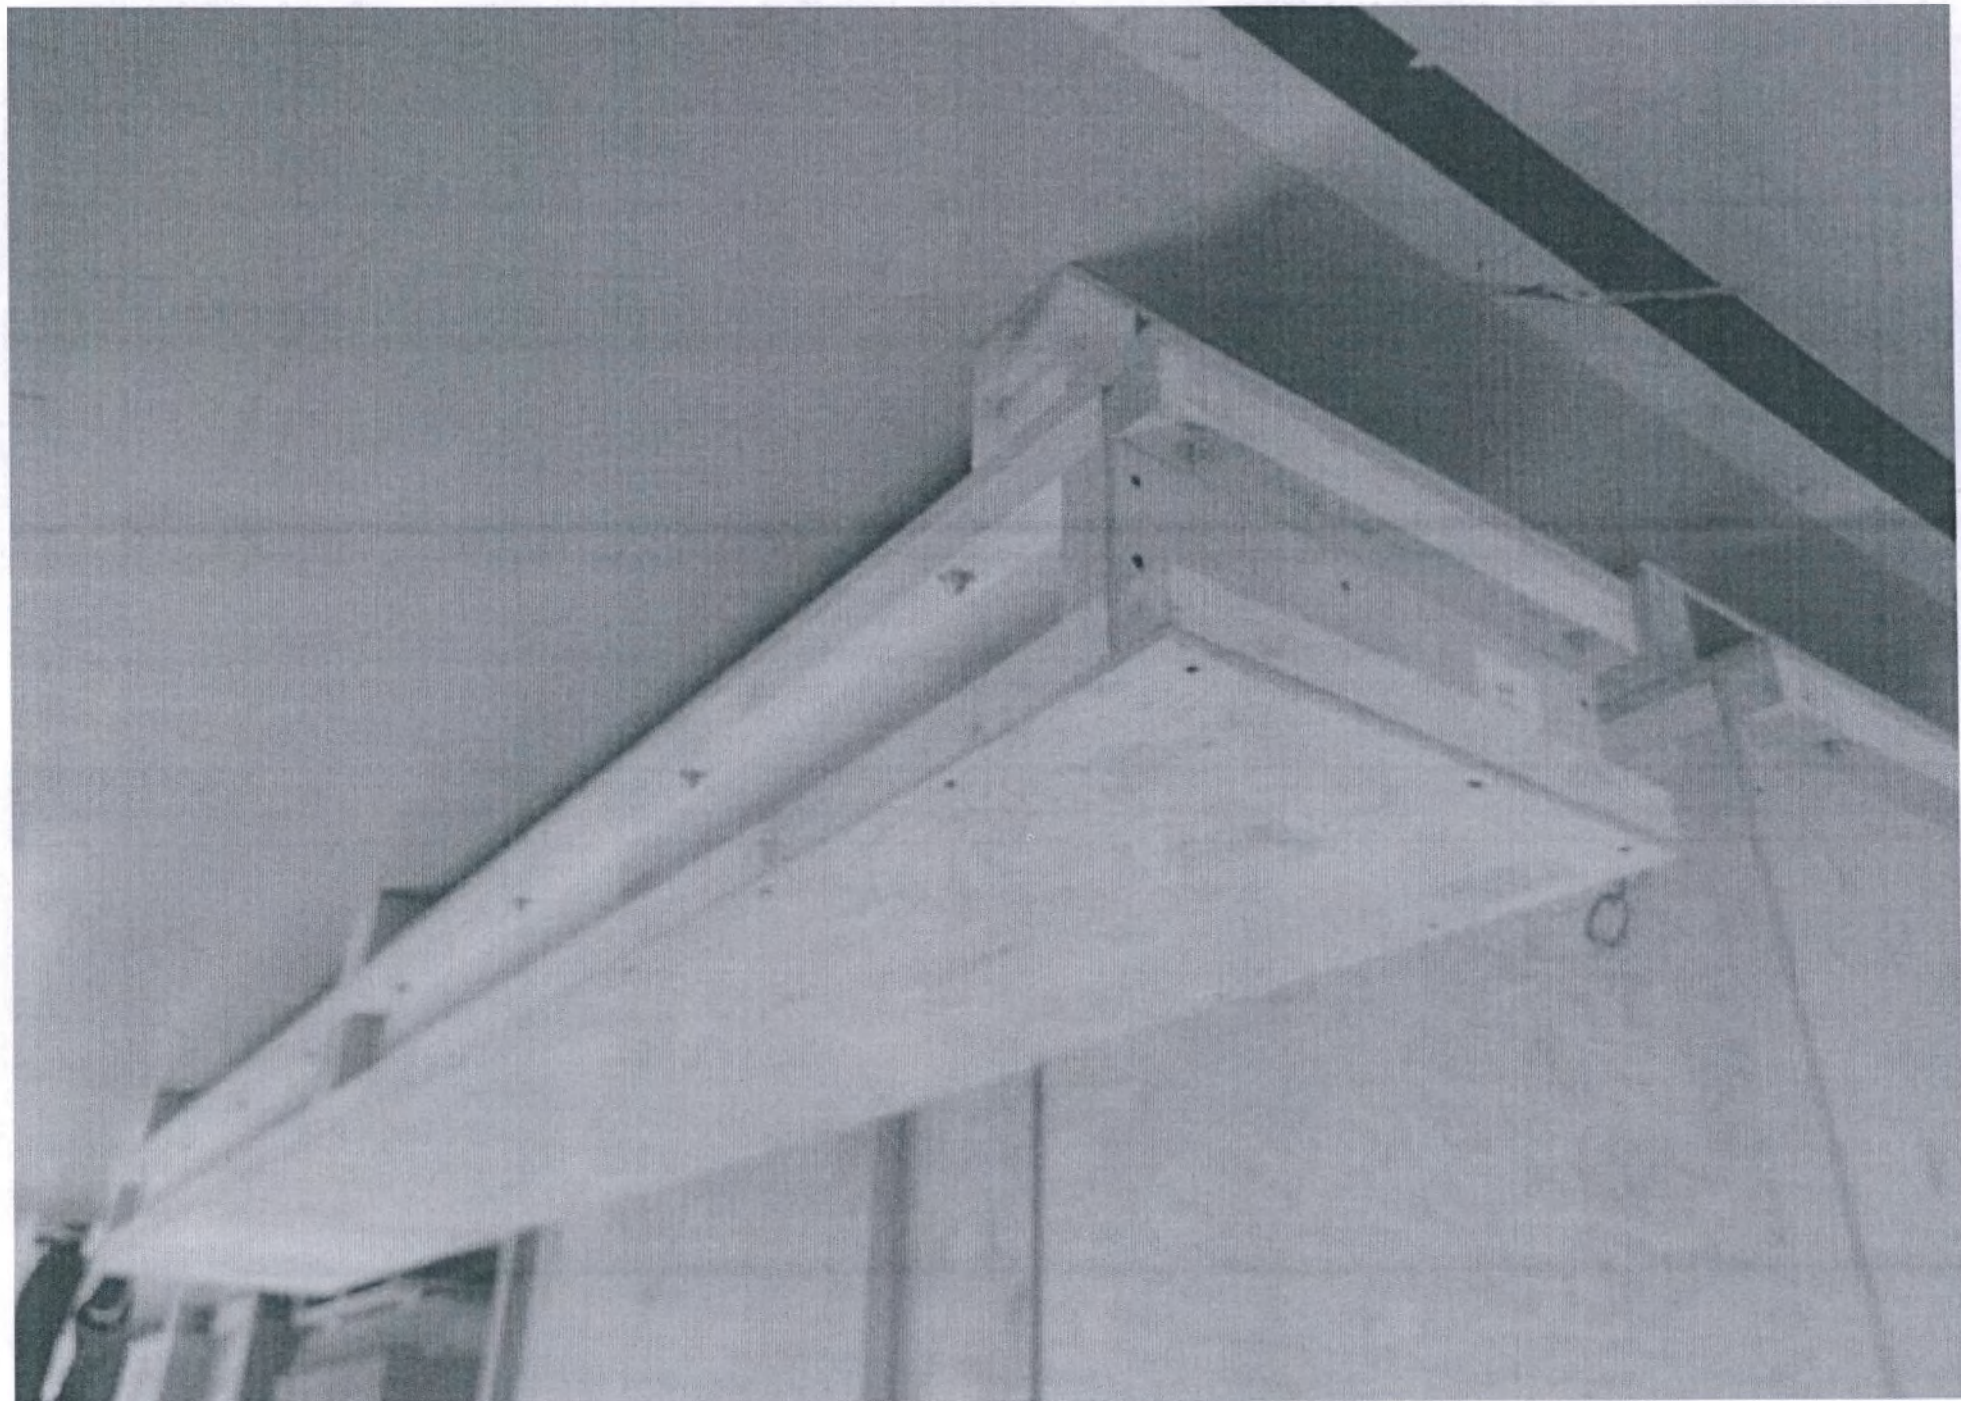


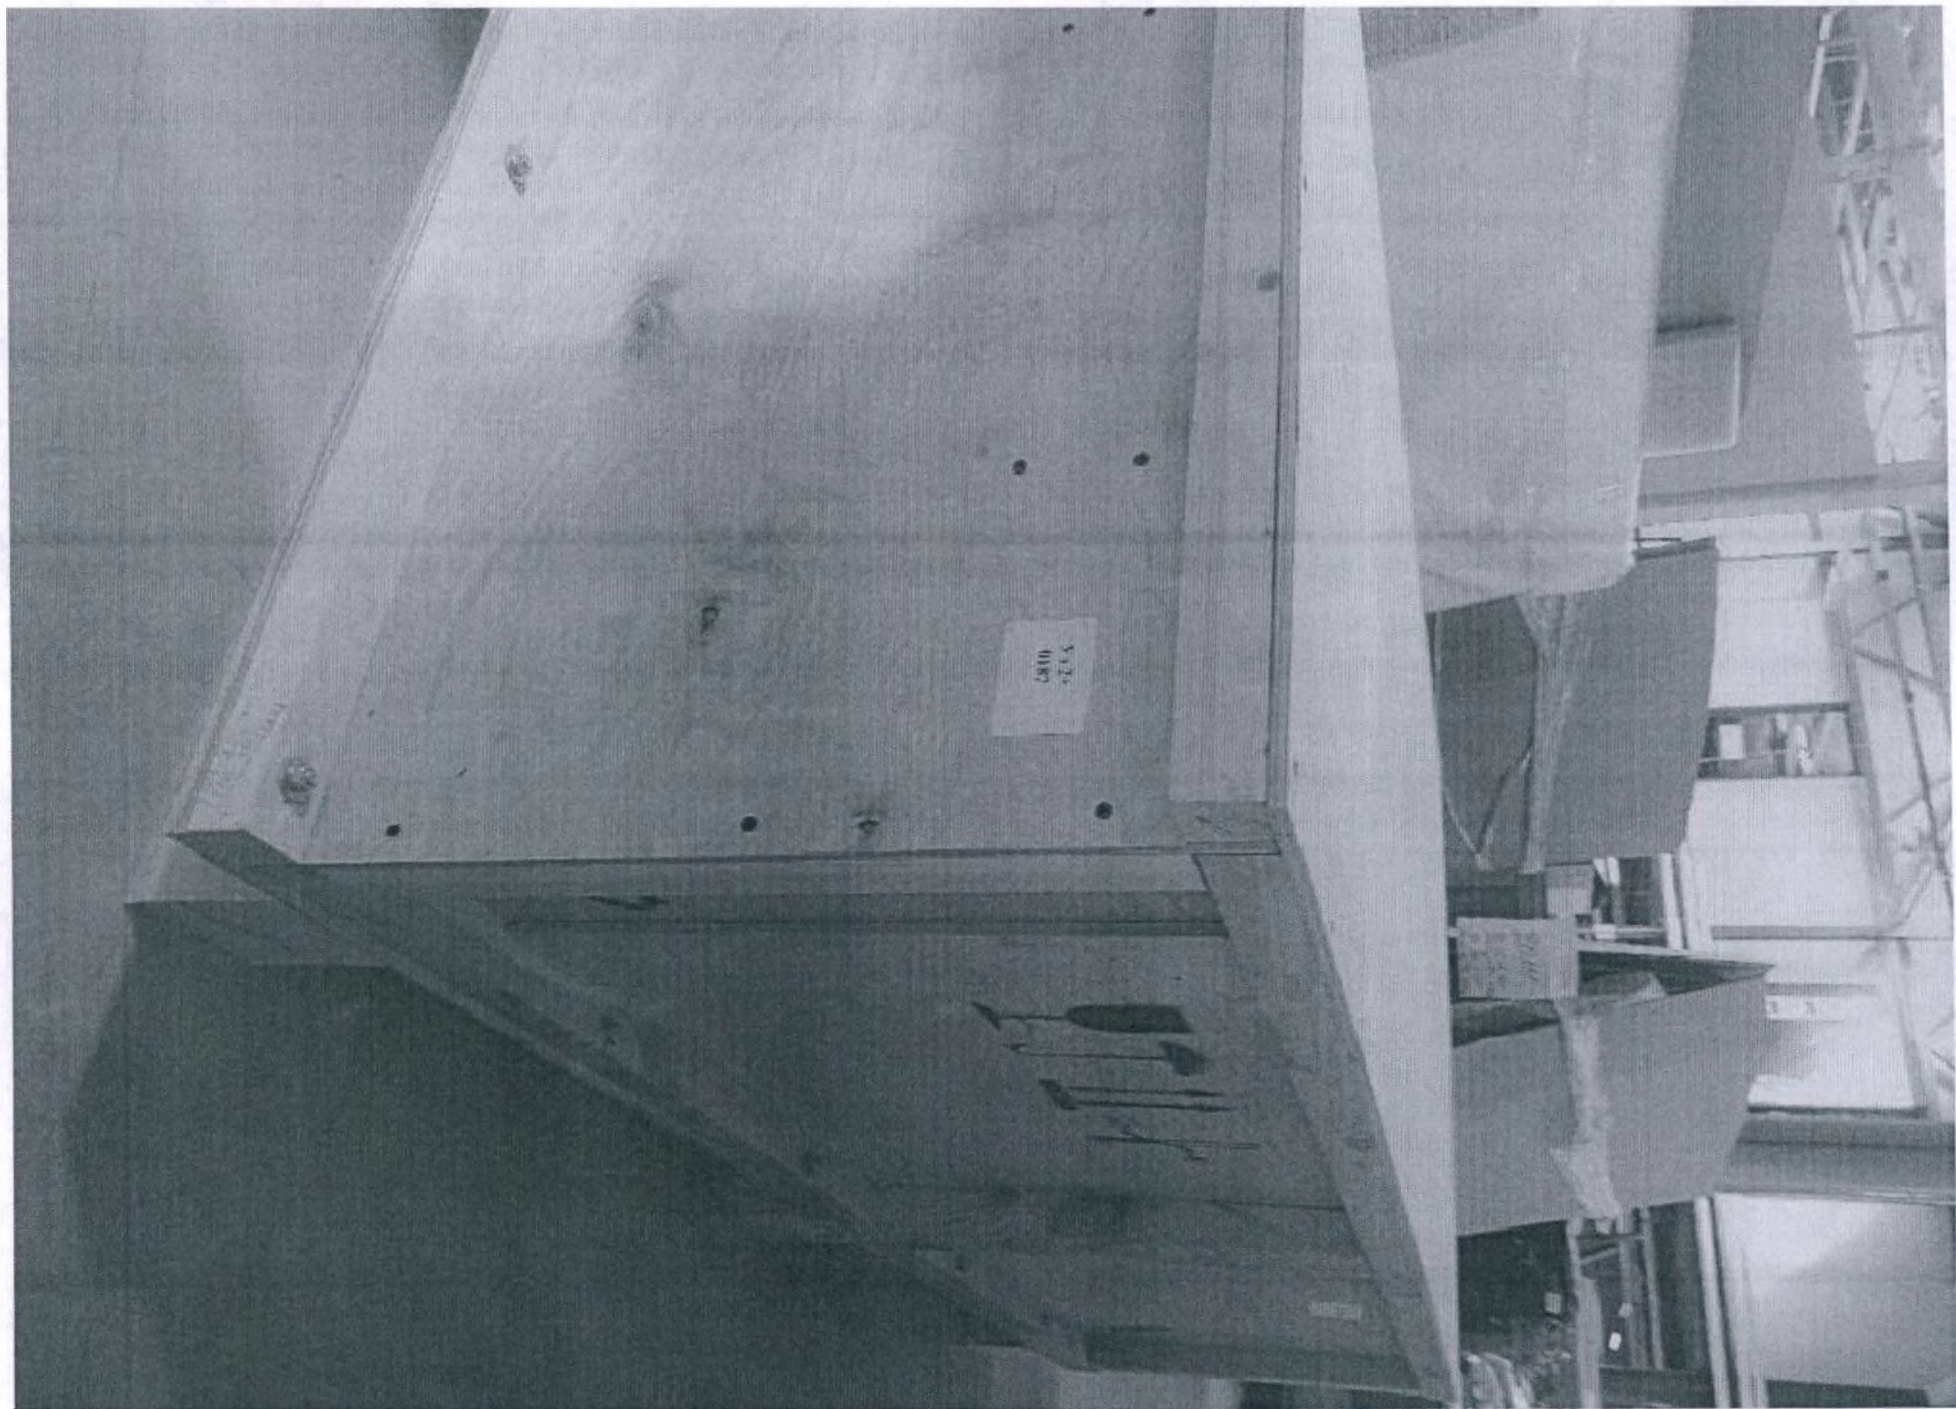




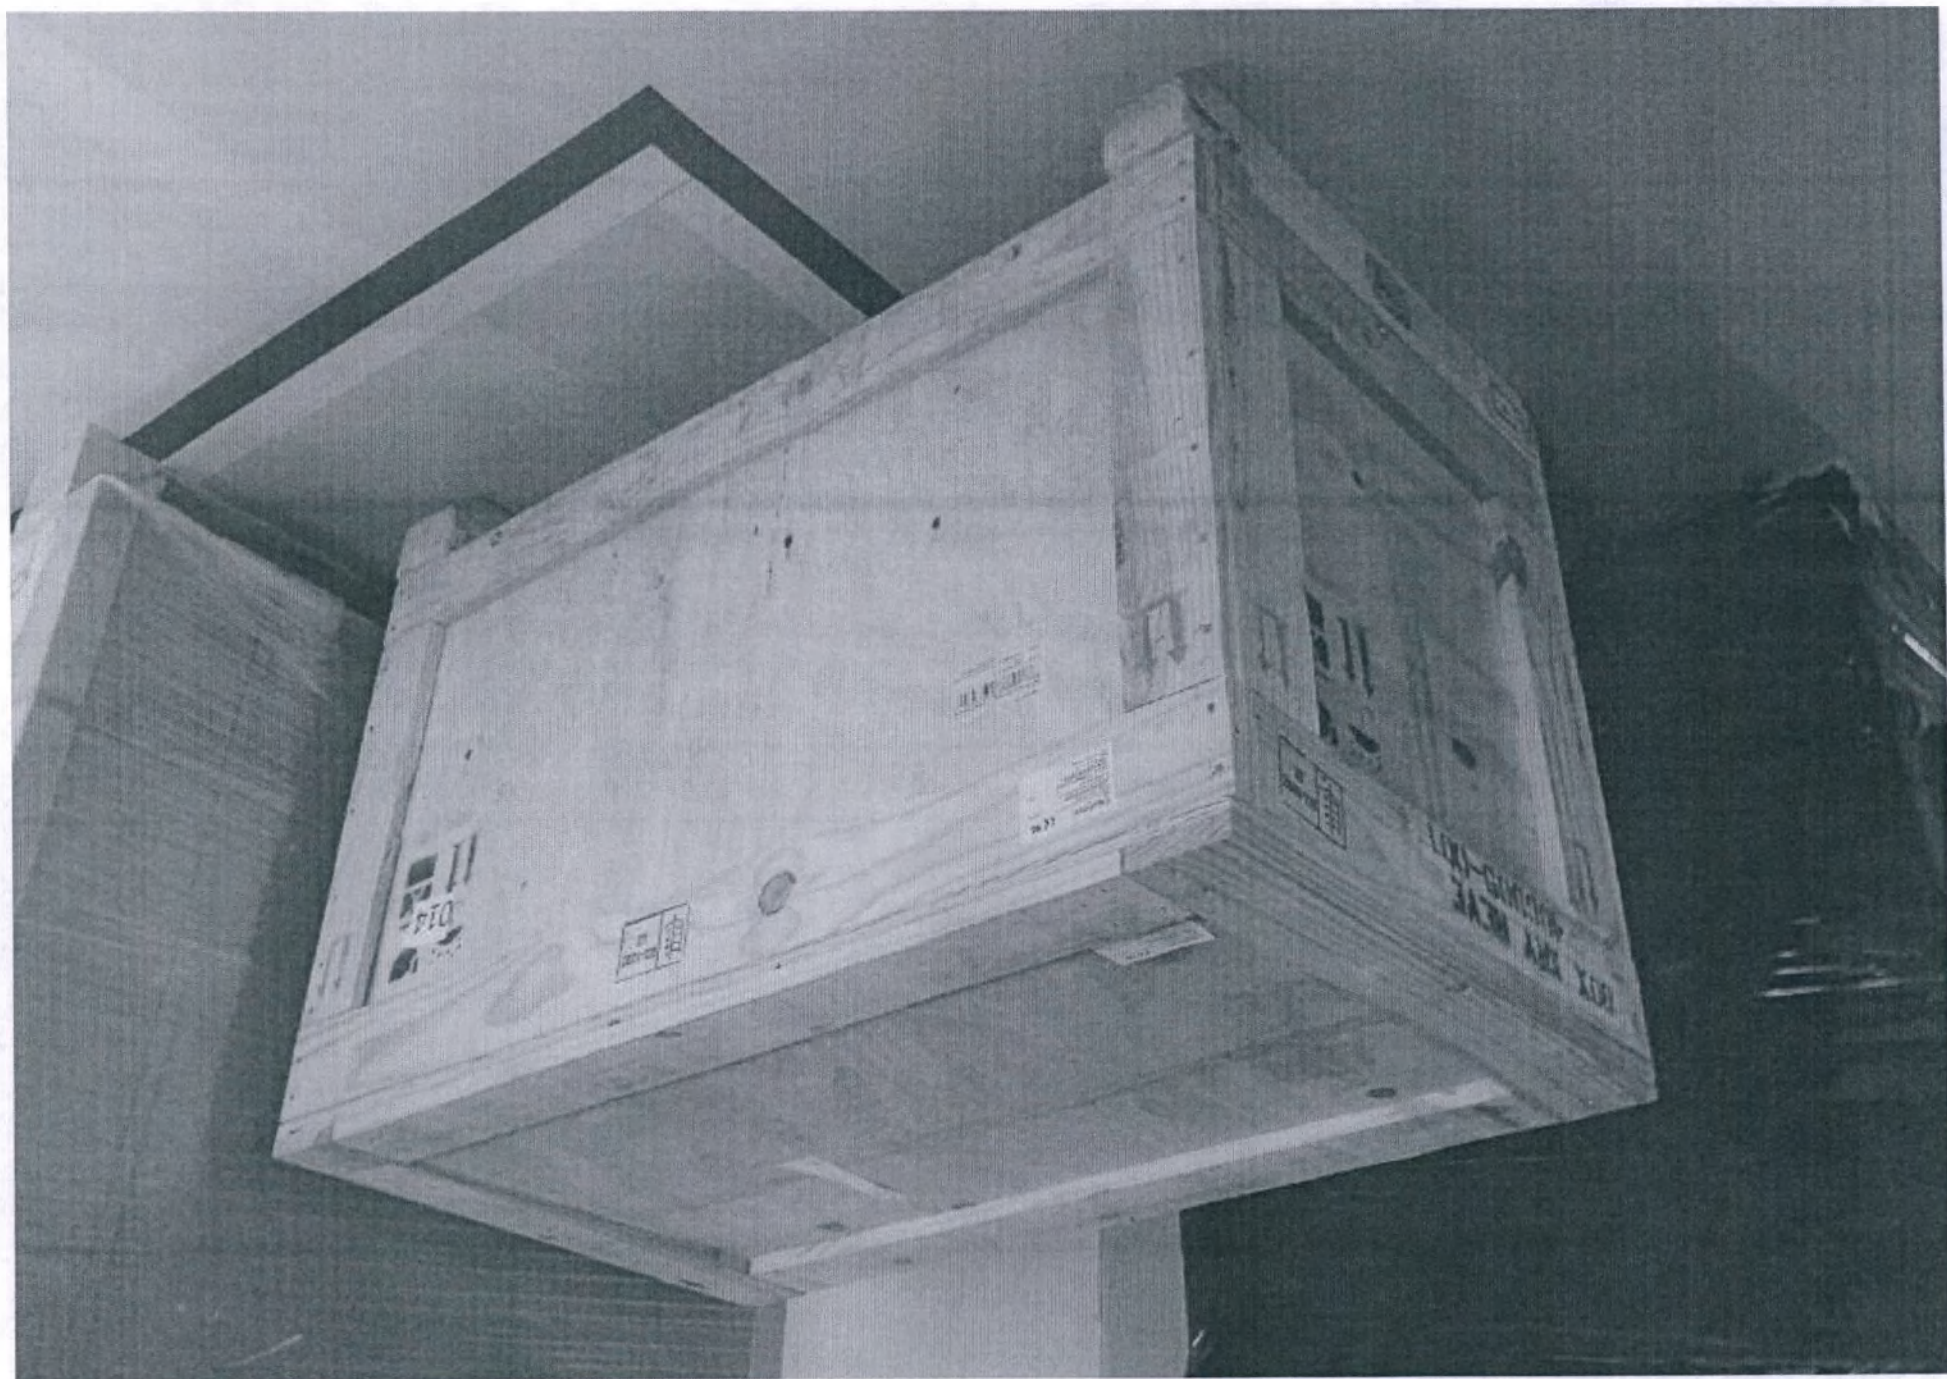

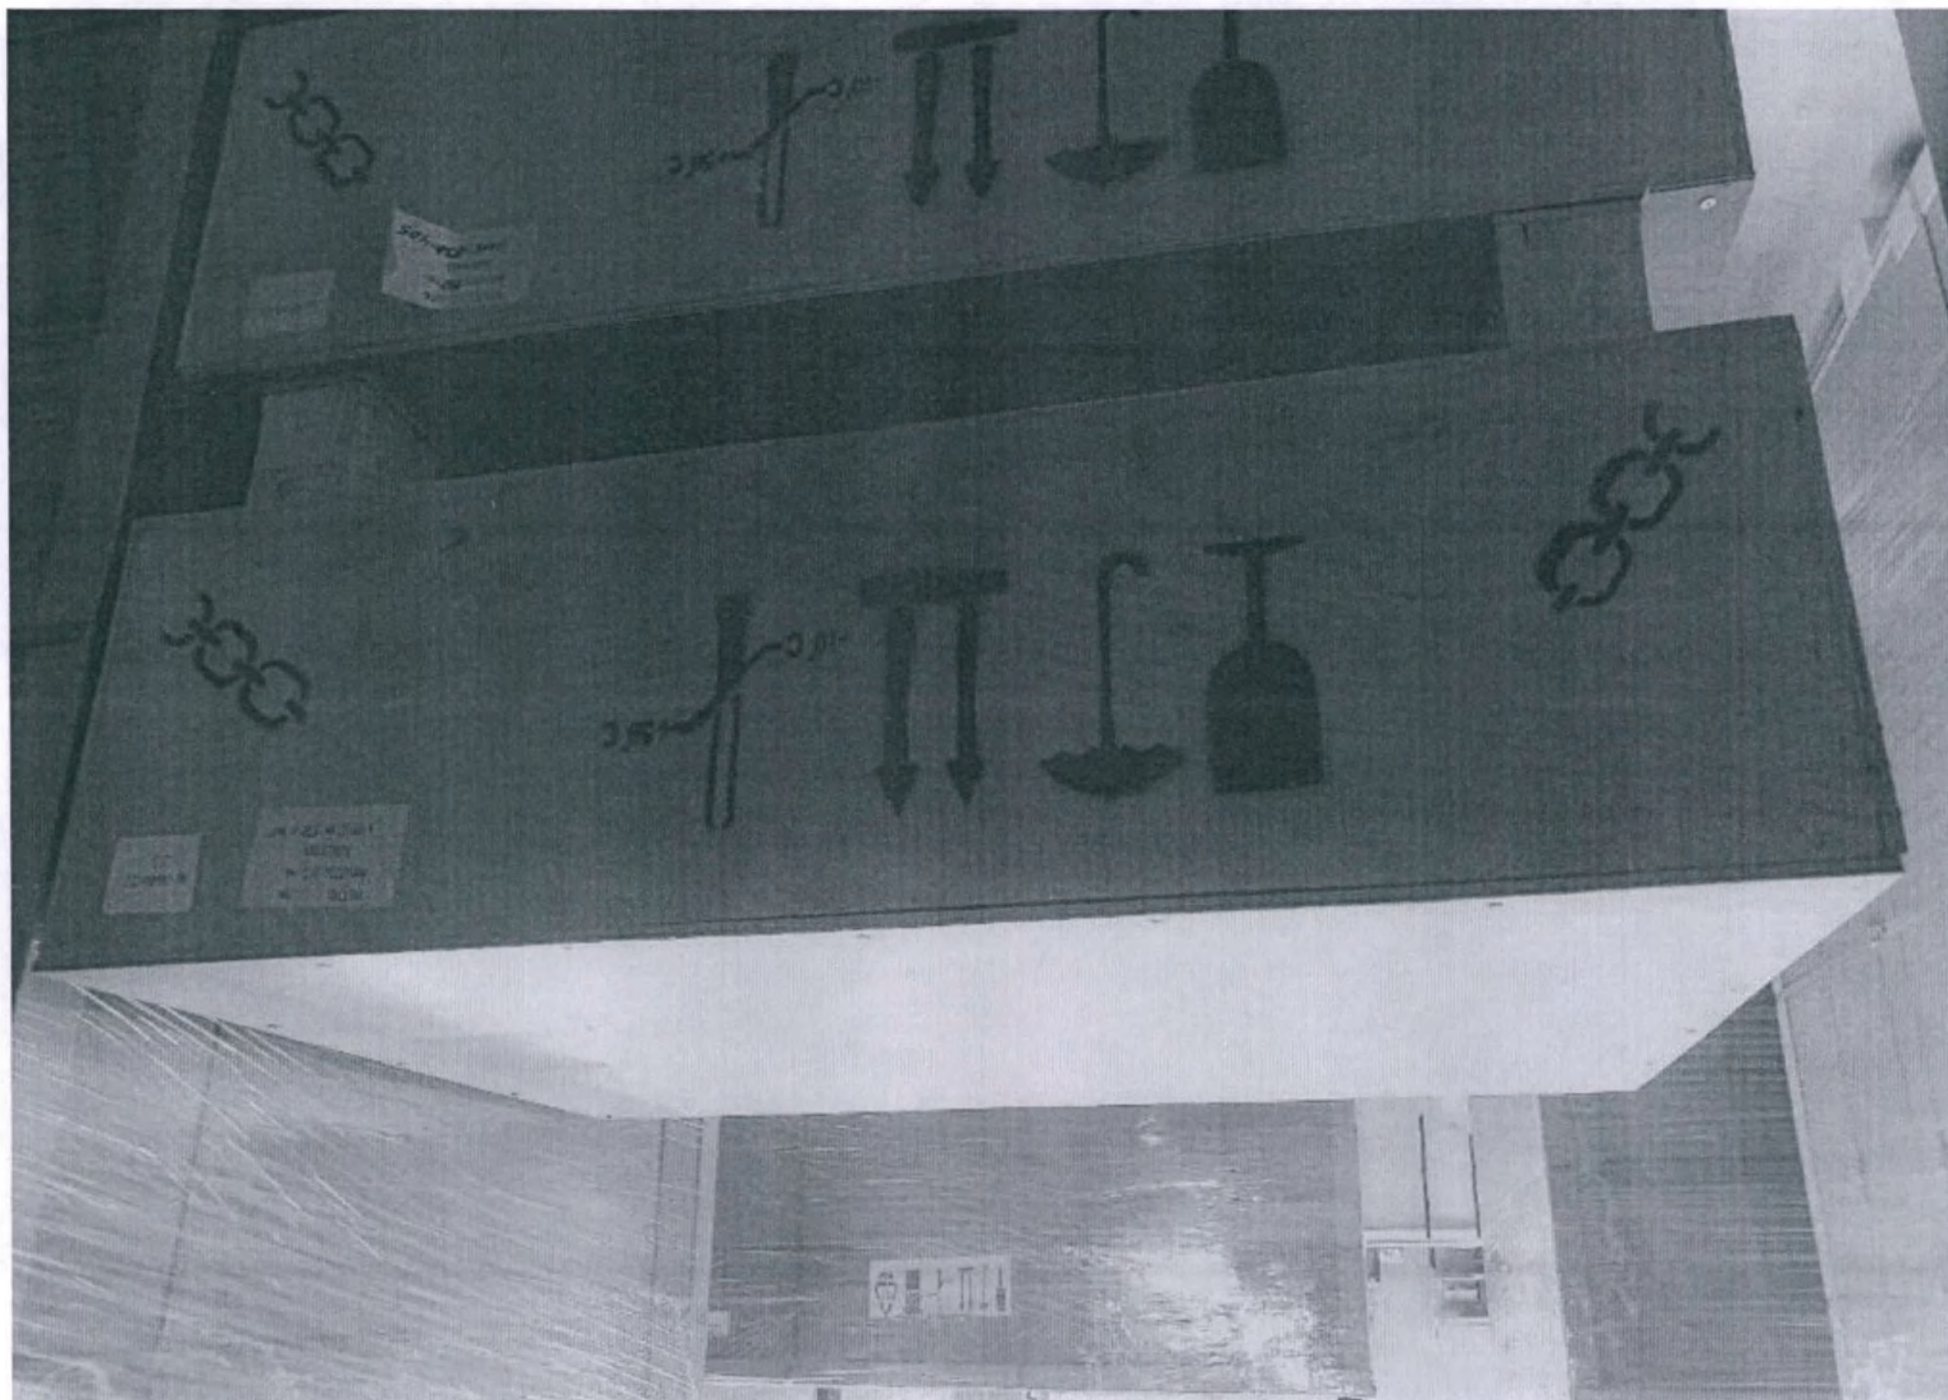

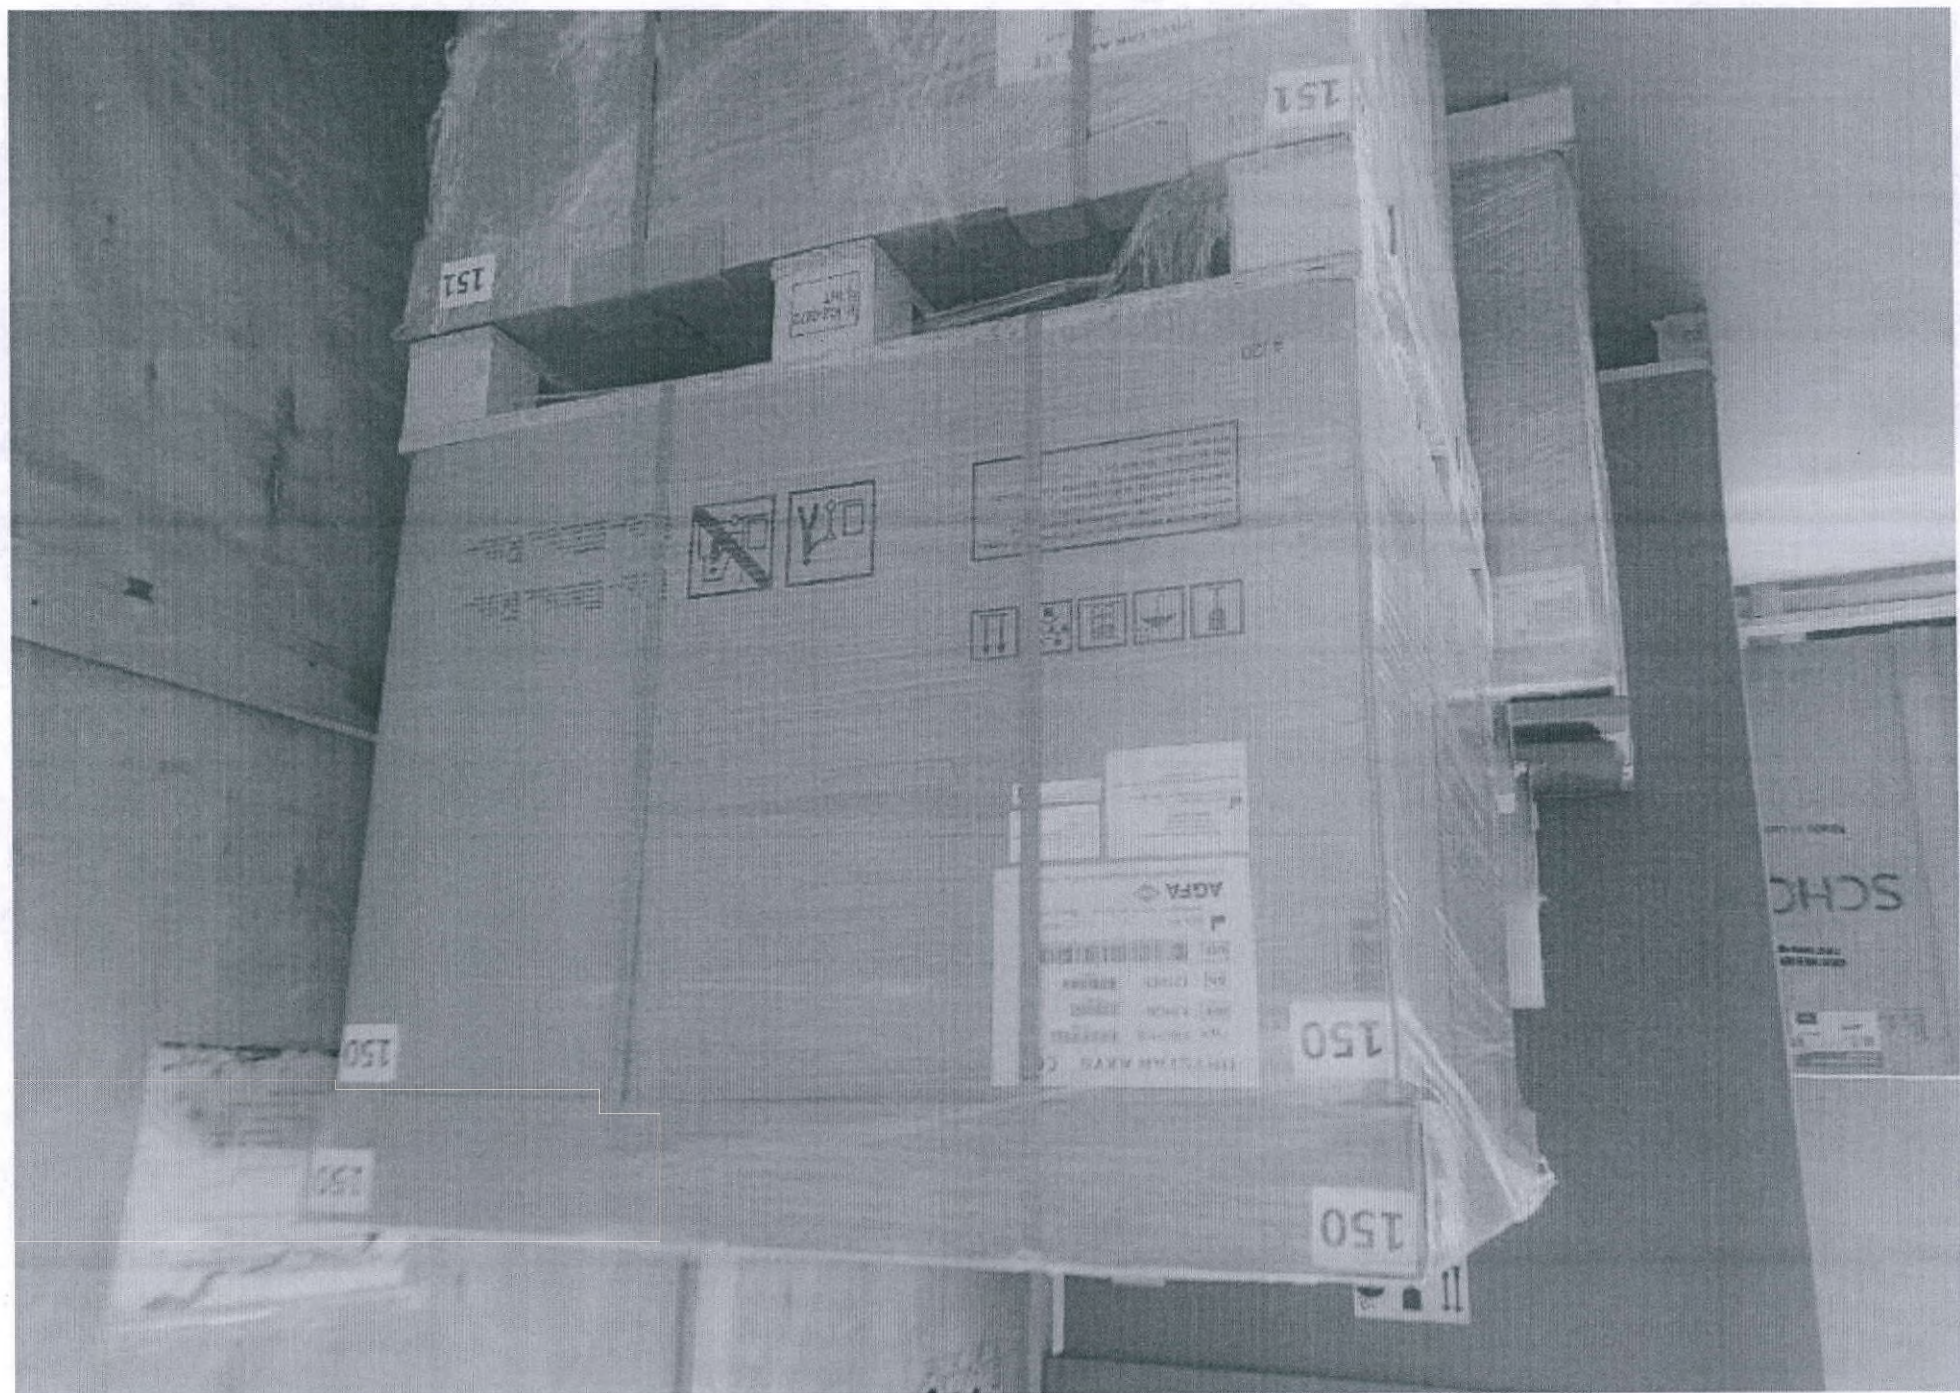

Образцы маркировки

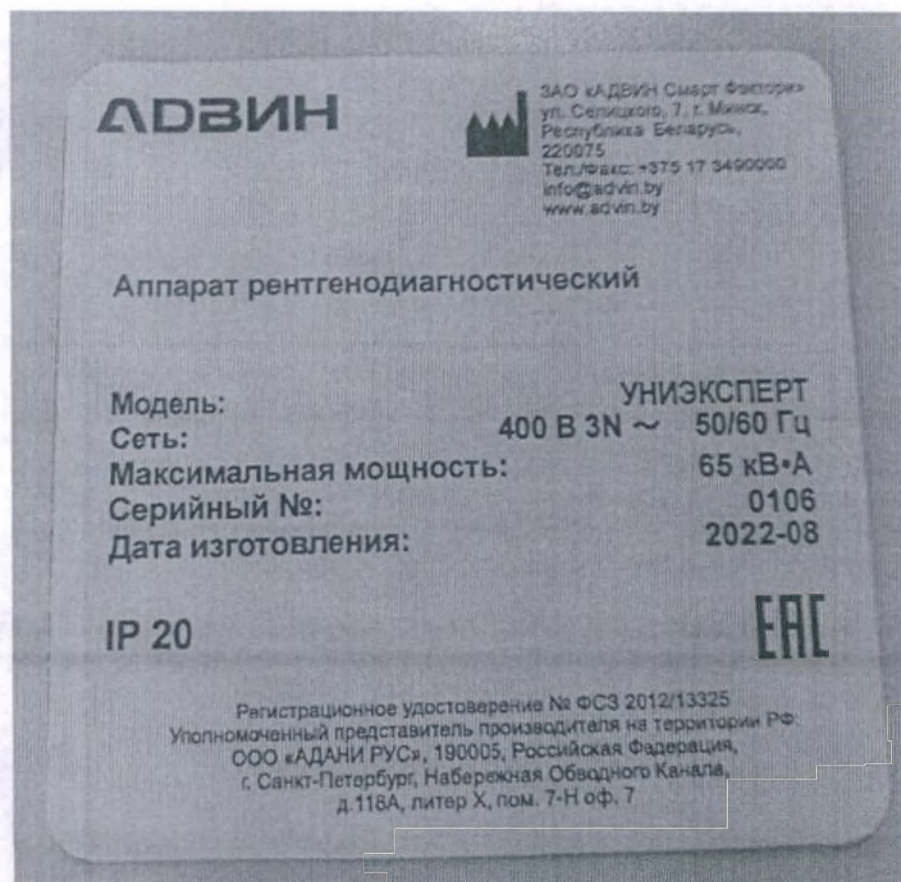

АДВИН



ЗАО «АДВИН Смарт Фактори»
ул. Селицкого, 7, г. Минск,
Республика Беларусь,
220075
Тел./Факс: +375 17 3490000
info@advin.by
www.advin.by

Аппарат рентгенодиагностический

Модель:	УНИЭКСПЕРТ 2 ПЛЮС
Сеть:	400 В 3N ~ 50/60 Гц
Максимальная мощность:	65 кВ·А
Серийный №:	0236
Дата изготовления:	2022-07

IP 20

EAC

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13325
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «АДАНИ РУС», 190005, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного Канала,
д.118А, литер Х, пом. 7-Н оф. 7

АДВИН



ЗАО «АДВИН Смарт Фактори»
ул. Селицкого, 7, г. Минск,
Республика Беларусь,
220075
Тел./Факс: +375 17 3490000
info@advin.by
www.advin.by

Аппарат рентгенодиагностический

Модель:	УНИЭКСПЕРТ 3 ПЛЮС
Сеть:	400 В 3N ~ 50/60 Гц
Максимальная мощность:	65 кВ•А
Серийный №:	0135
Дата изготовления:	2022-07

IP 20

EAC

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13325
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «АДАНИ РУС», 190005, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного Канала,
д. 118А, литер Х, пом. 7-Н оф. 7



Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
358 листа (ов)
Генеральный Директор ООО "АДАНИ РУС"
/В.О. Скачков/