

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко

«06» октября 2022 г.*




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени

«SARS-CoV-2-скрин-Amp»

серия 1, серия 2

1. Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин-Амр», серия 1 (общий вид)

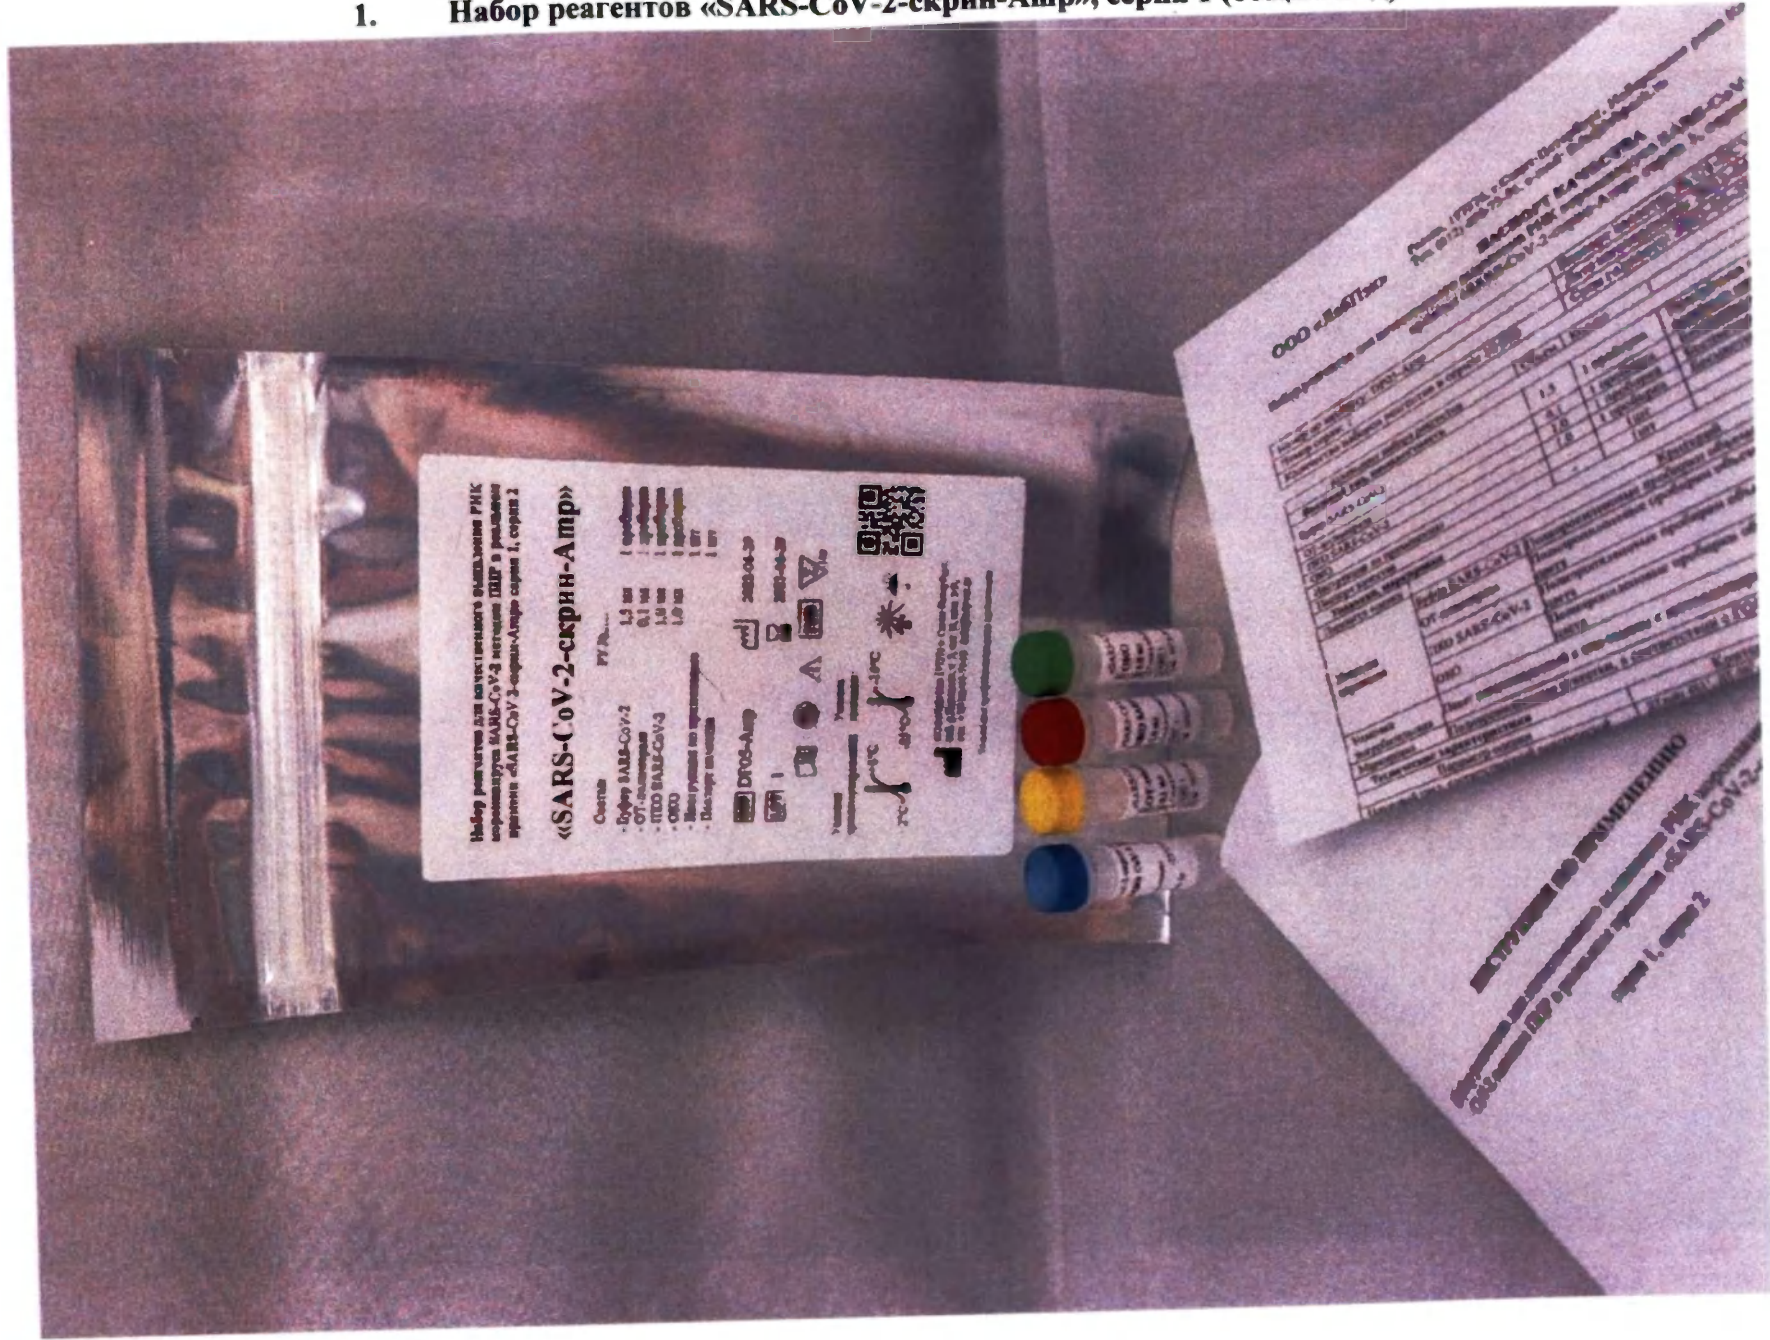

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

Набор реагентов для качественного выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном
времени «SARS-CoV-2-скрин-Амп» серия 1, серия 2

«SARS-CoV-2-скрин-Амп»

Состав:

РУ №.....

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка
- Инструкция по применению		1 шт
- Паспорт качества		1 шт

 DP05-Amp

 2022-06-29



 LOT 1

 2023-06-29



Условия
транспортирования:




Условия
хранения:






ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения


1.1. Буфер SARS-CoV-2

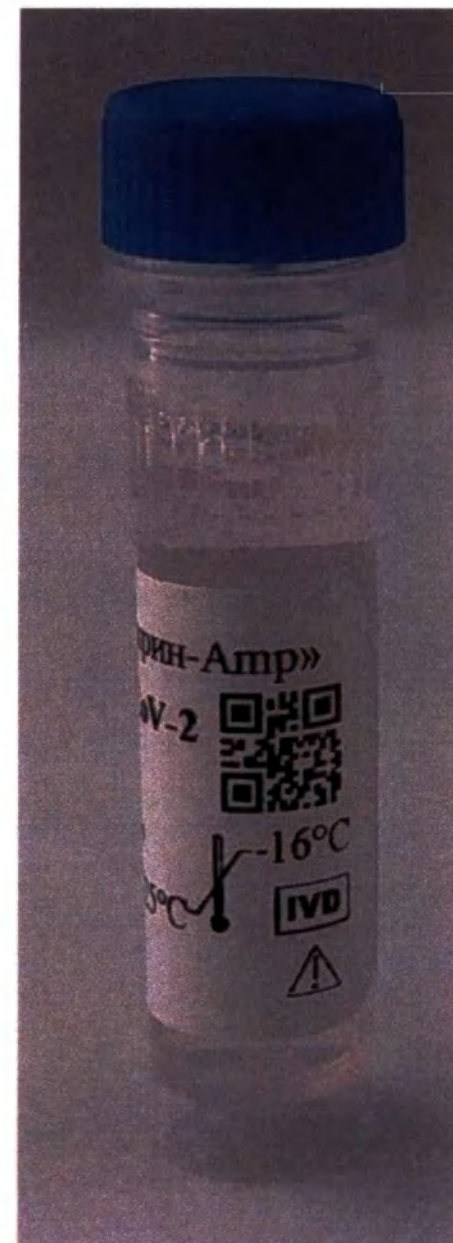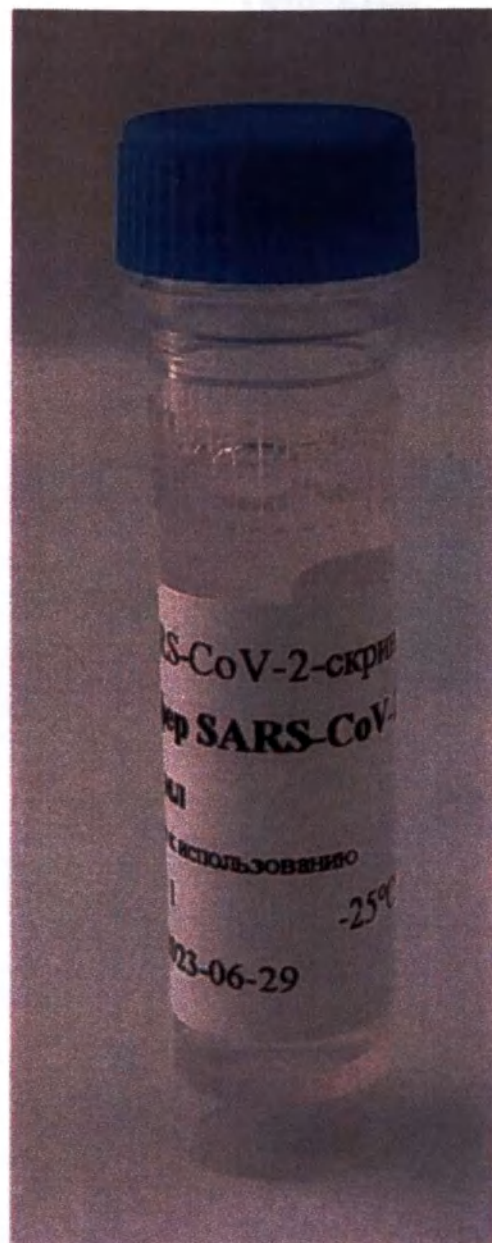
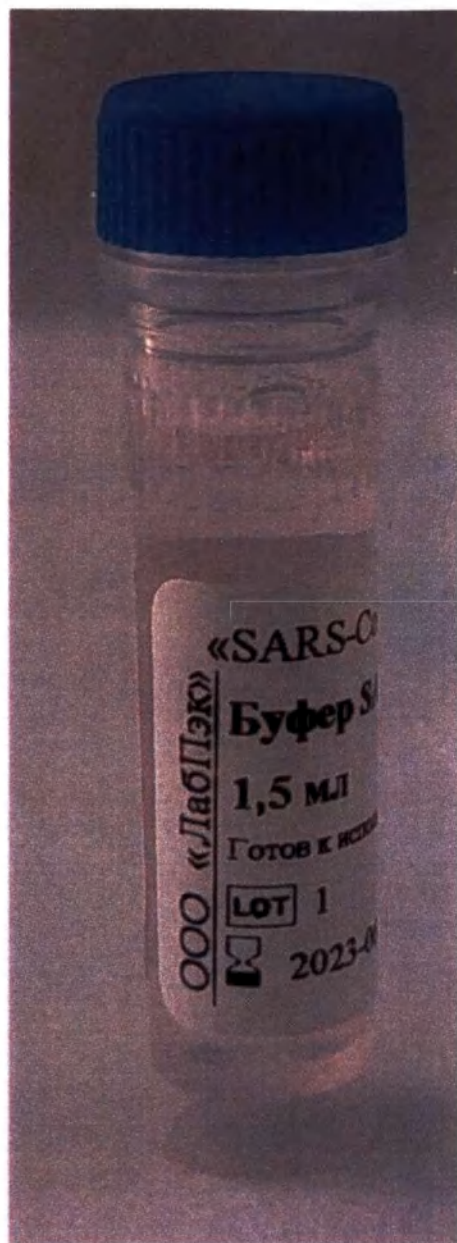


1.2. ОТ-полимераза

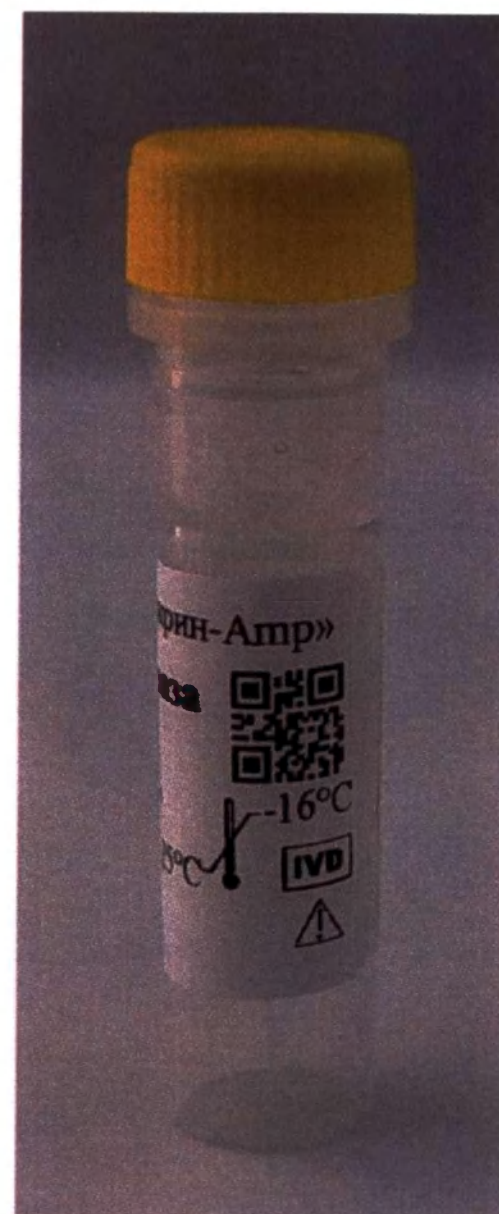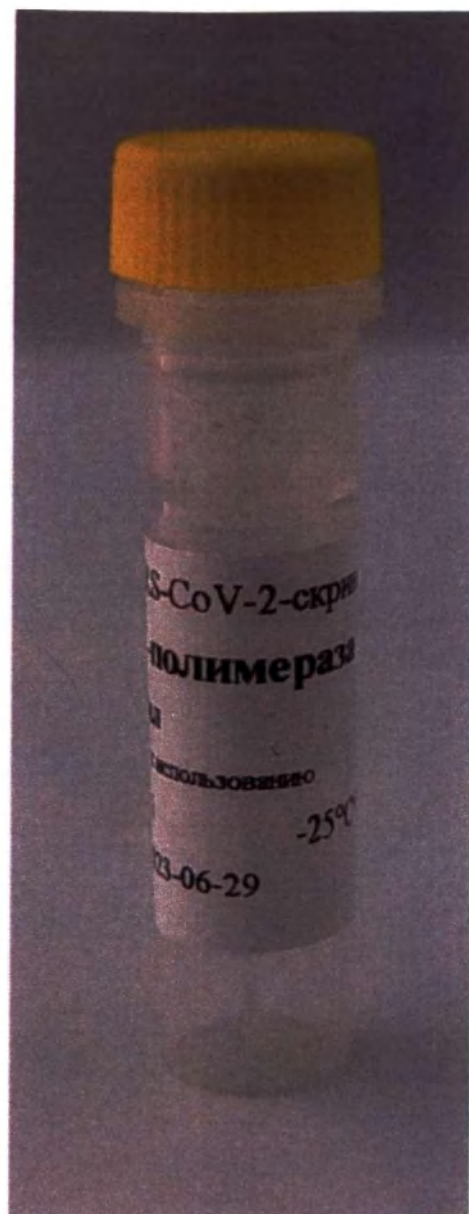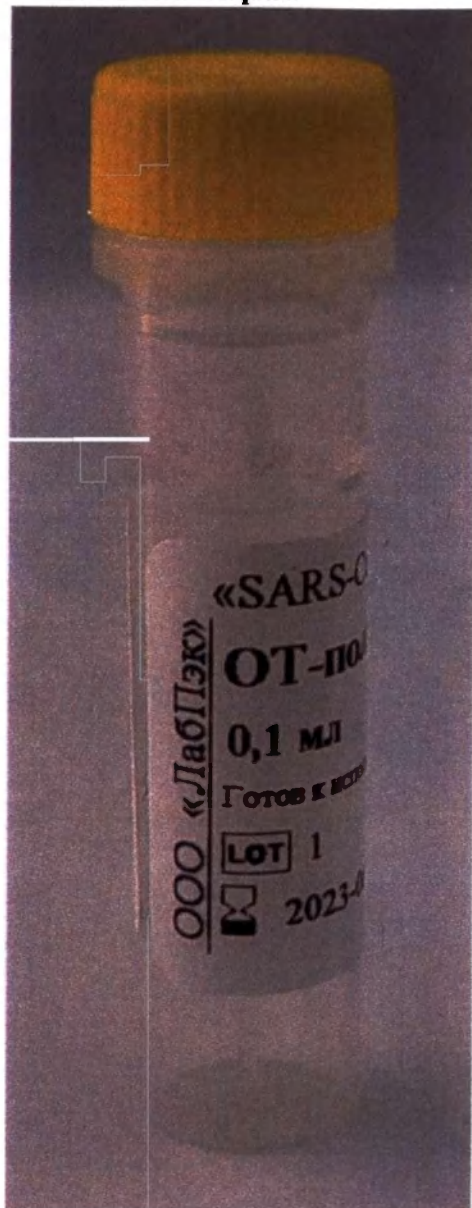

1.3. ПКО SARS-CoV-2

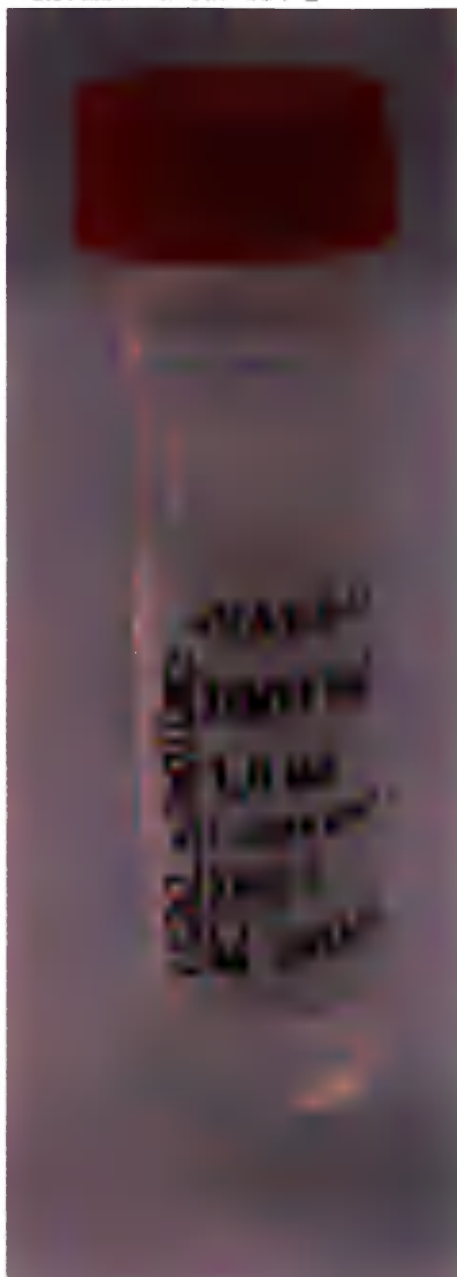

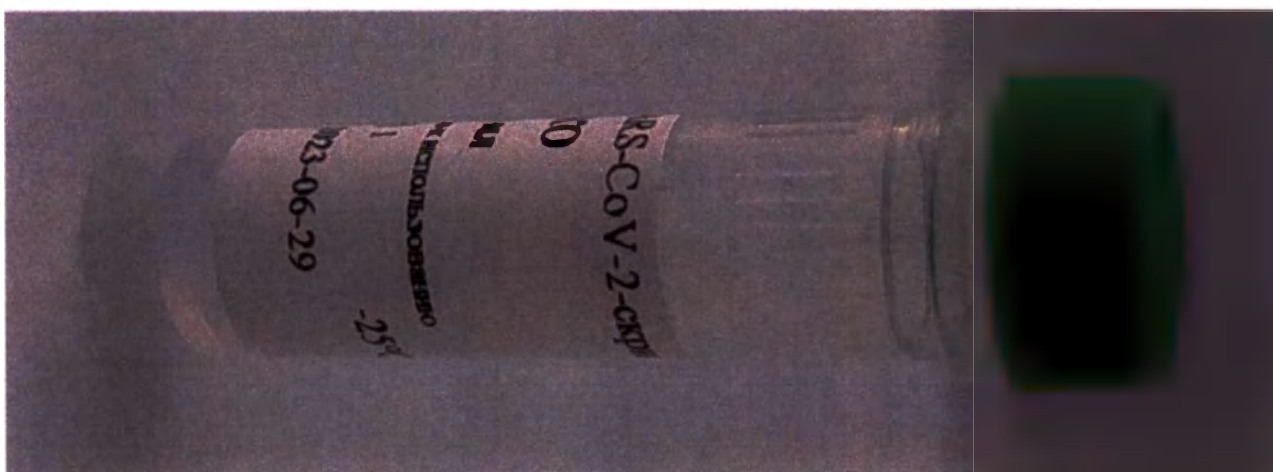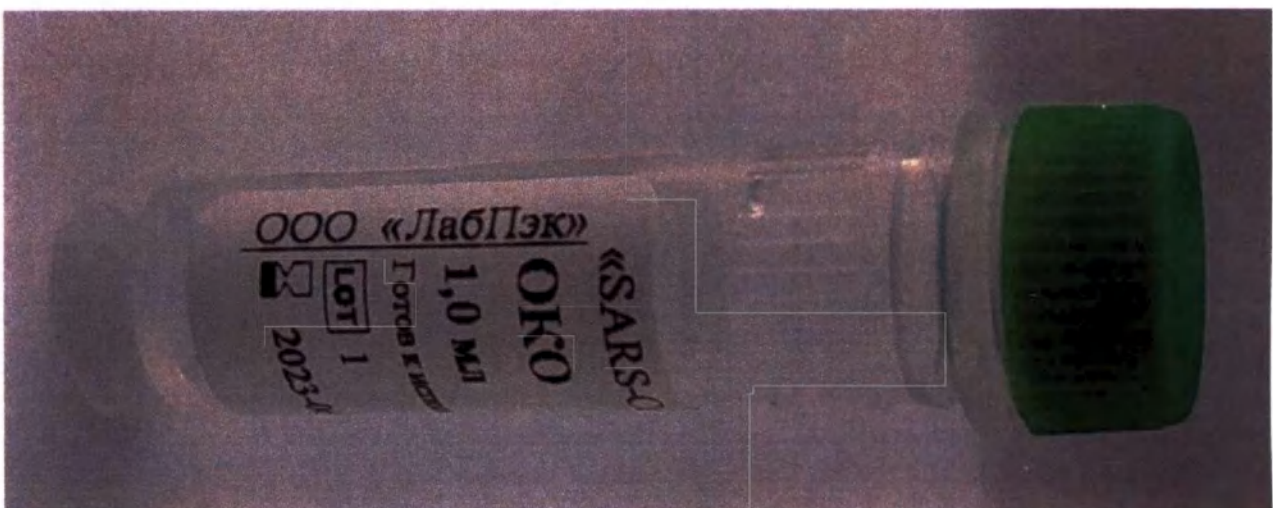



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

Набор реагентов для качественного выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном
времени «SARS-CoV-2-скрин-Амп» серия 1, серия 2

«SARS-CoV-2-скрин-Амп»

Состав:

РУ №.....

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка
- Инструкция по применению		1 шт
- Паспорт качества		1 шт

REF DP05-Amp



2022-07-04

LOT 2



2023-07-04




Условия
транспортировки:

Условия
хранения:

+8°C
-2°C






-16°C
-25°C





ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург,
наб. р. Касперова, д. 5, лит. И, пом. 3-Н,
тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения



2.1. Буфер SARS-CoV-2

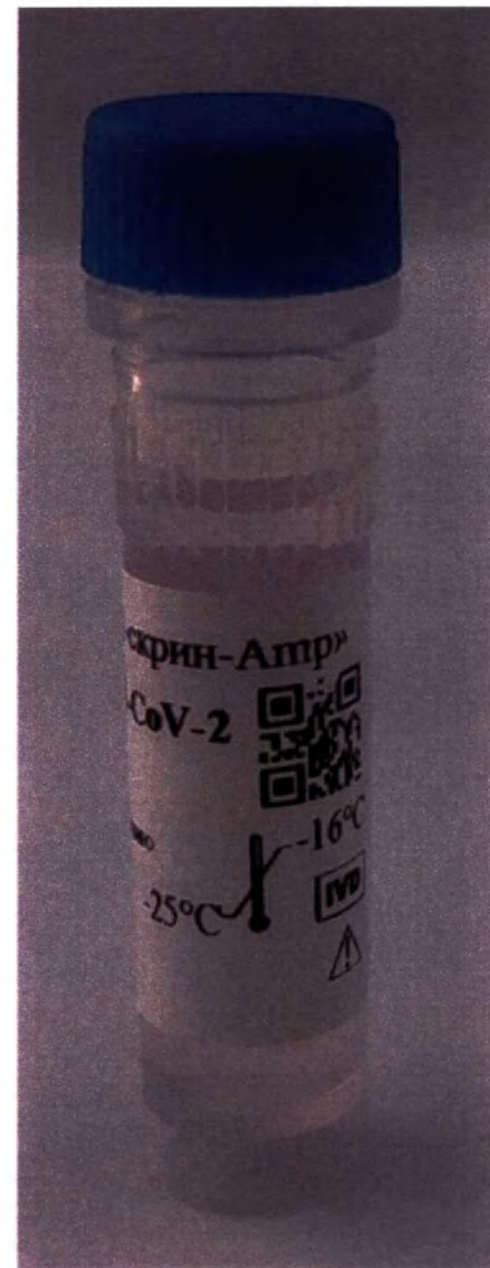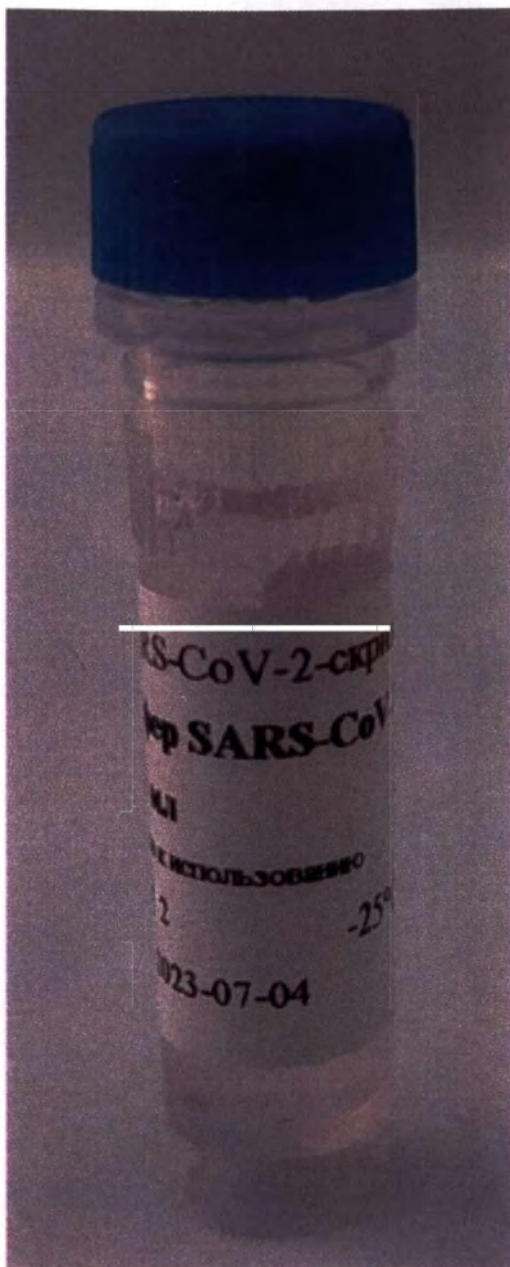
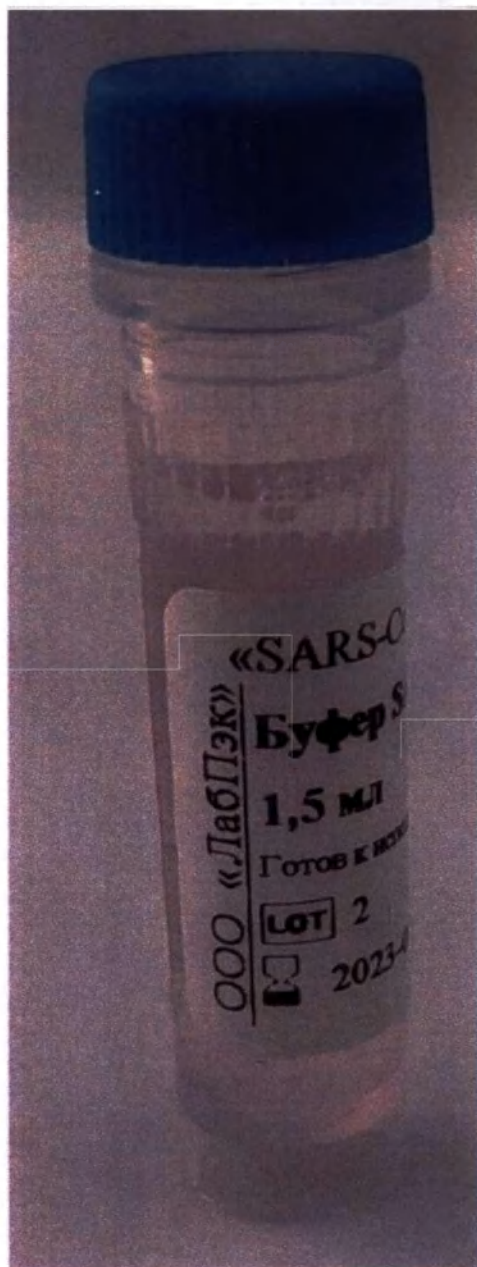


2.2. ОТ-полимераза

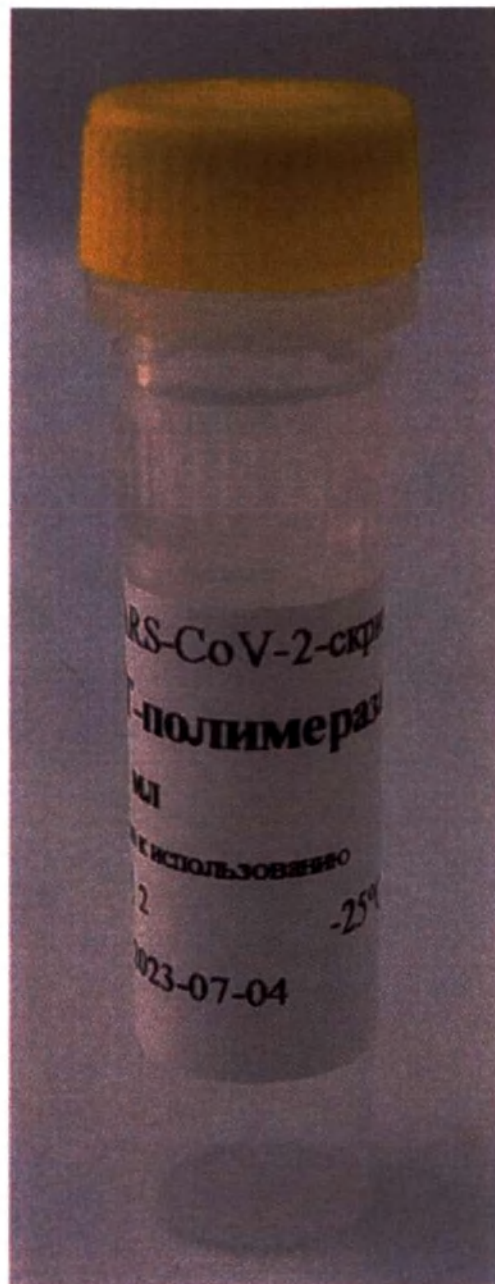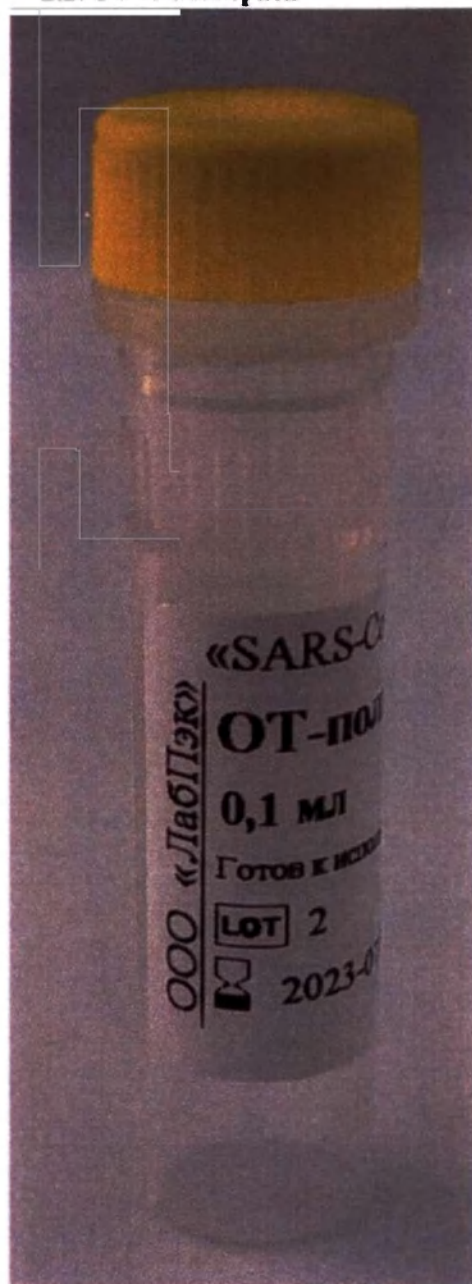

2.3. ПКО SARS-CoV-2

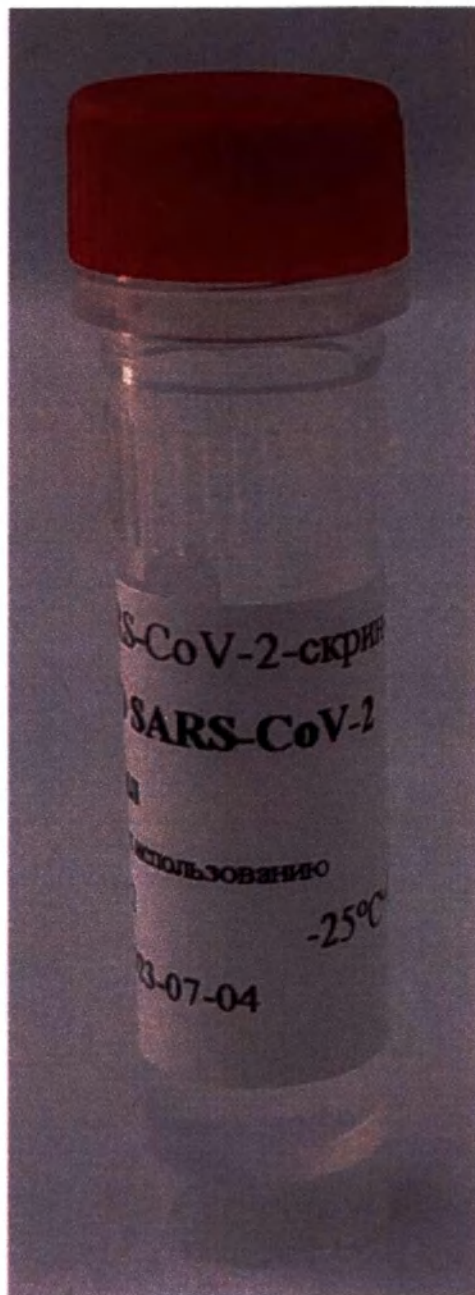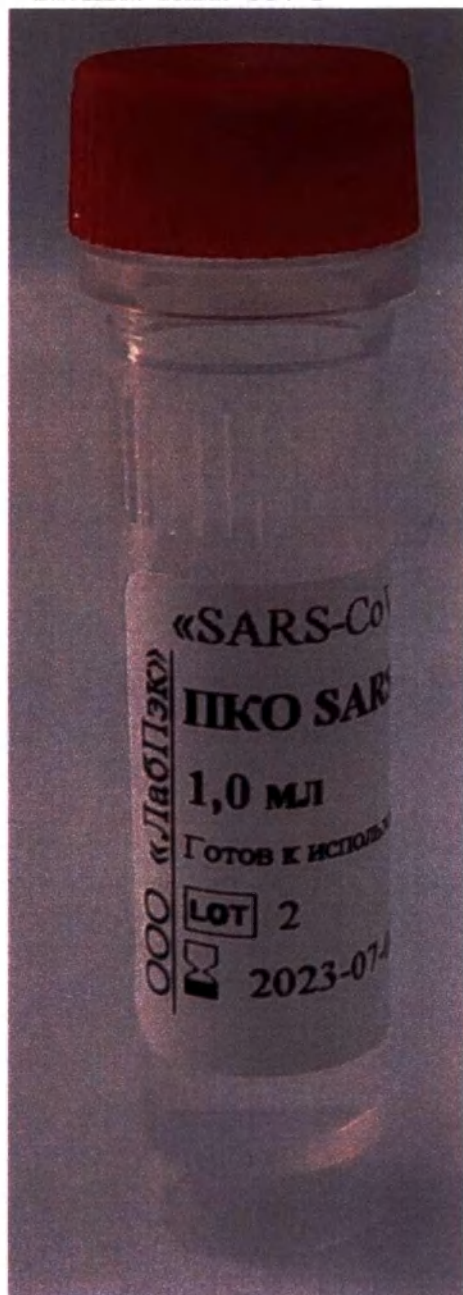

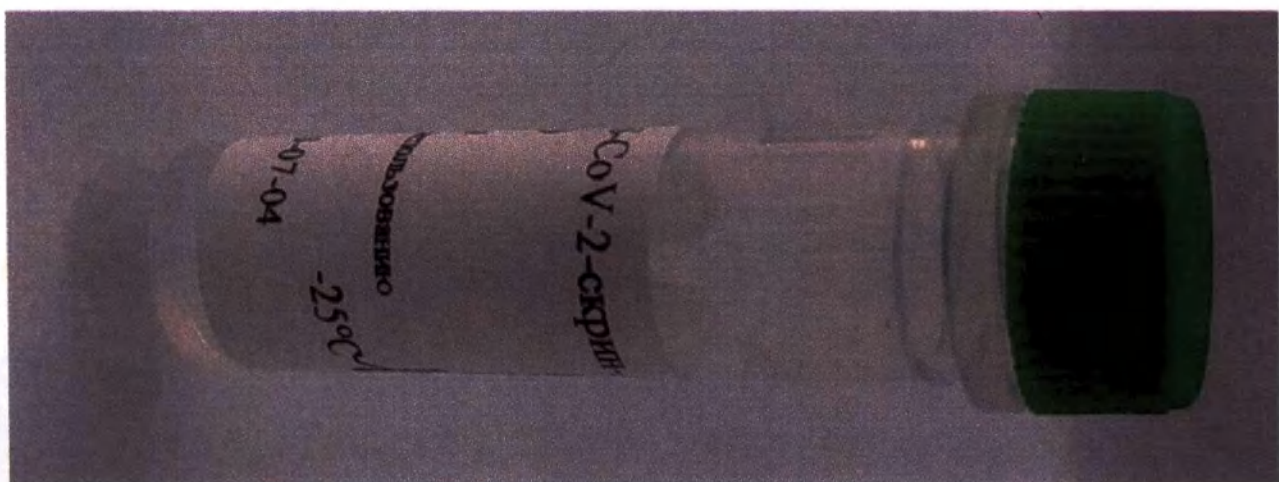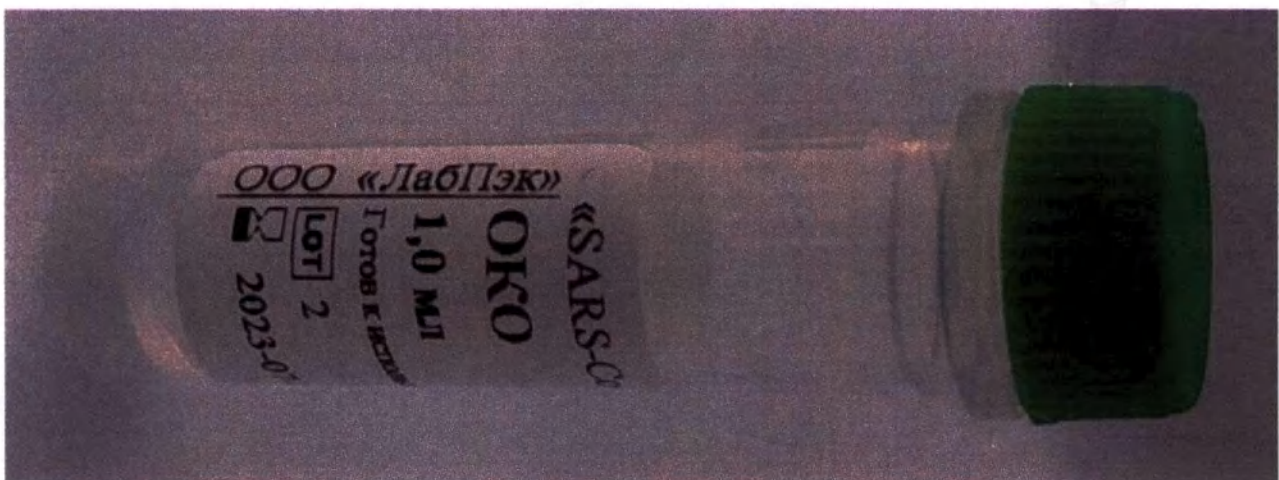



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко/




Маркировка первичной, потребительской и групповой (транспортной) упаковки.

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-Амп» серия 1, серия 2


1. «SARS-CoV-2-скрин-Амп» серия 1

1.1. Образцы маркировки первичной упаковки:

Буфер SARS-CoV-2

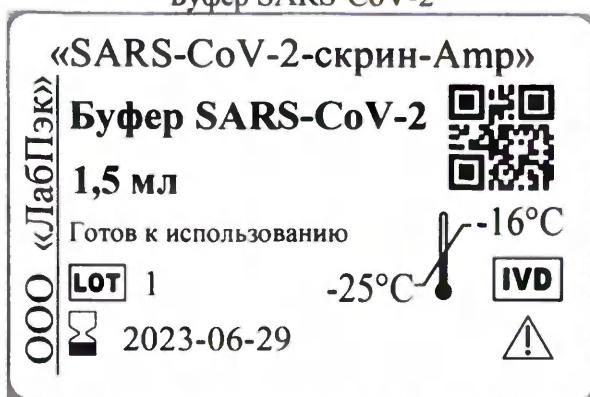

ОТ-полимераза

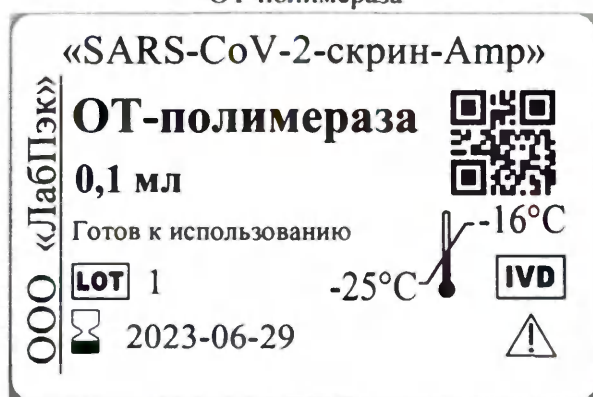

ПКО SARS-CoV-2



ОКО



1.2. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-Amp» серия 1, серия 2

«SARS-CoV-2-скрин-Amp»

Состав: РУ №.....

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка
- Инструкция по применению		1 шт
- Паспорт качества		1 шт

REF DP05-Amp  2022-06-29

LOT 1  2023-06-29

   **IVD** 

Условия транспортирования: Условия хранения:

+2°C  +8°C  -16°C 

+25°C  -25°C 

 ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения



1.3. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. (812) 490-75-93, E-mail: info@labpack.ru, https://www.labpack.ru

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-Amp» серия 1, серия 2

Число единиц потребительской упаковки изделий..... шт

Масса нетто групповой упаковки кг

Масса брутто групповой упаковки..... кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

REF DP05-Amp


LOT 1

Срок годности: 2023-06

Условия транспортирования: Условия хранения:

+2°C  +8°C      -16°C


+25°C  -25°C 


2. «SARS-CoV-2-скрин-Амп» серия 2

2.1. Образцы маркировки первичной упаковки:

Буфер SARS-CoV-2

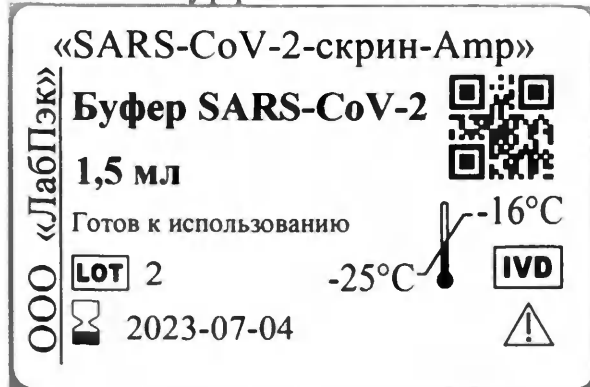


ОТ-полимераза

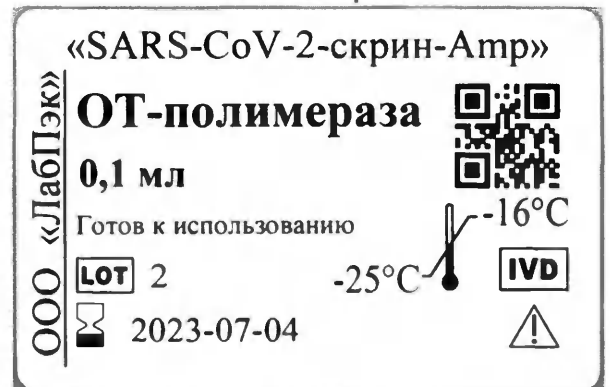

ПКО SARS-CoV-2



ОКО

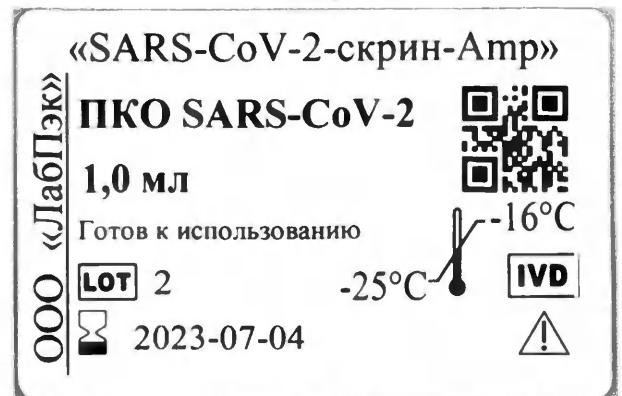

2.2. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-Amp» серия 1, серия 2

«SARS-CoV-2-скрин-Amp»

Состав: РУ №.....

- Буфер SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка
- Инструкция по применению		1 шт
- Паспорт качества		1 шт

REF DP05-Amp  2022-07-04

LOT 2  2023-07-04

   **IVD** 

Условия транспортирования: Условия хранения:

+2°C — +8°C —16°C —25°C   

 ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Только для профессионального применения

2.3. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. (812) 490-75-93, E-mail: info@labpack.ru, https://www.labpack.ru

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-Amp» серия 1, серия 2



REF DP05-Amp

LOT 2

Срок годности: 2023-07

Число единиц потребительской упаковки изделий..... шт
 Масса нетто групповой упаковки..... кг
 Масса брутто групповой упаковки..... кг
 Масса нетто потребительской упаковки..... кг

Условия транспортирования: Условия хранения:

+2°C — +8°C —16°C —25°C    