



Макеты маркировки

Реанимационная система для новорожденных Giraffe
Omnibed Carestation с принадлежностями

Директор департамента
по регистрации и сертификации
Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

Харитонов А.П.

доверенность № 9/22-М от 20.04.2022

«28» марта 2023 г.



	3	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе	9	Беречь от влаги
	4	Температурный диапазон, при котором МИ надежно сохраняется	10	Знак СЕ и код органа сертификации
	5	Диапазон влажности, при котором МИ надежно сохраняется	11	Дата изготовления
	6	Ограничение атмосферного давления, при котором МИ надежно сохраняется		


Примечание:
На маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Блок контроля подачи кислорода				
	1	Наименование производителя и/или адрес производителя		
	2	Наименование изделия		
	3	Каталожный номер		
	4	Серийный номер		

Примечание:
На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Лампа фототерапии со световодом, СЕ или IEC				
	1	Каталожный номер		

2	Наименование изделия
3	Серийный номер

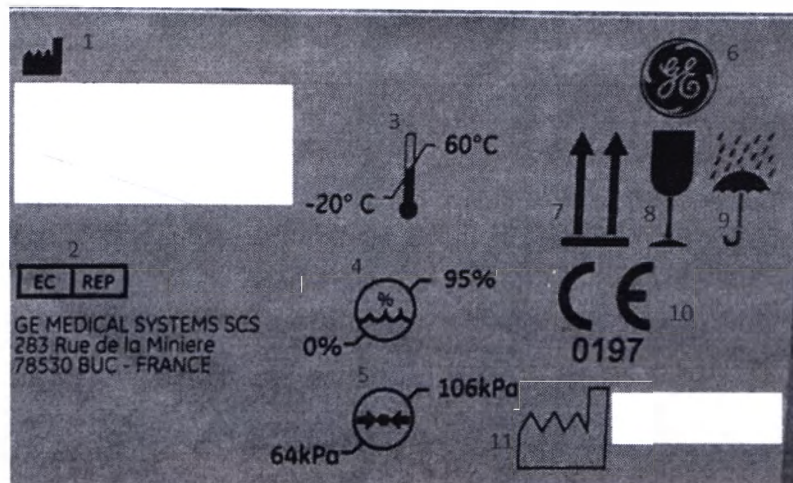

1	Наименование производителя и/или адрес производителя	7	Вверх
2	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе	8	Хрупкое, обращаться с осторожностью
3	Температурный диапазон, при котором изделие надежно сохраняется	9	Беречь от влаги
4	Диапазон влажности, при котором изделие надежно сохраняется	10	Знак CE и код органа сертификации
5	Ограничение атмосферного давления, при котором изделие надежно сохраняется	11	Дата производства
6	Наименование и логотип компании		

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация.


Датчики кислорода

1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Серийный номер
4	Наименование производителя и/или адрес производителя
5	Страна производства

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Датчики для измерения температуры для новорожденных, одноразовые

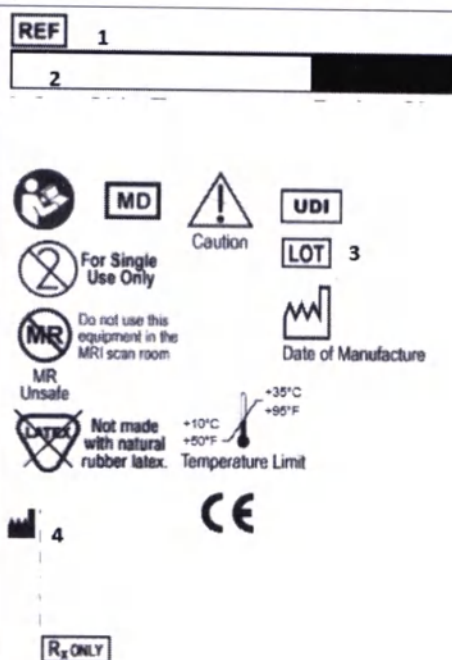


1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Серийный номер
4	Производитель

Примечание:


На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Датчики для измерения температуры для новорожденных, многоразовые

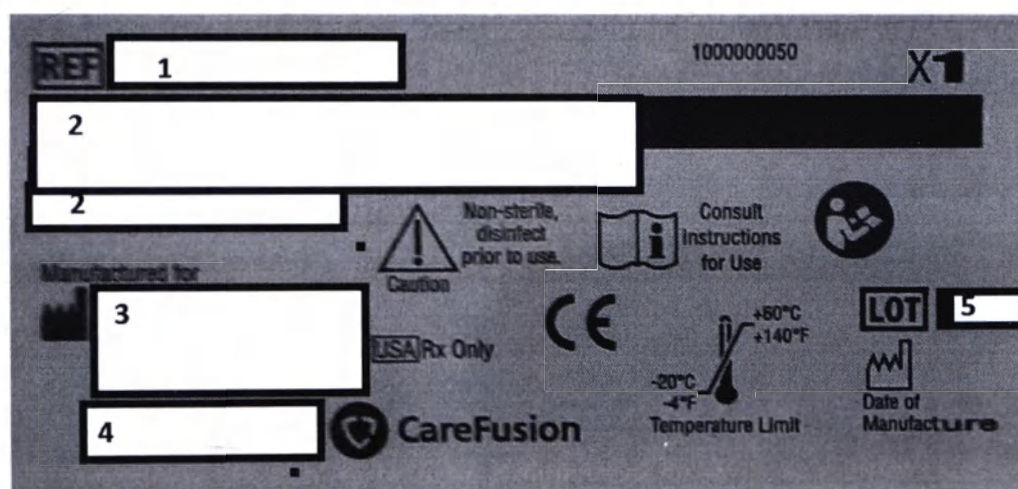

1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Производитель
4	Производственная площадка
5	Серийный номер

Пластырь
теплоотражающ
ий,
одноразовый,
для крепления
температурного
датчика на коже

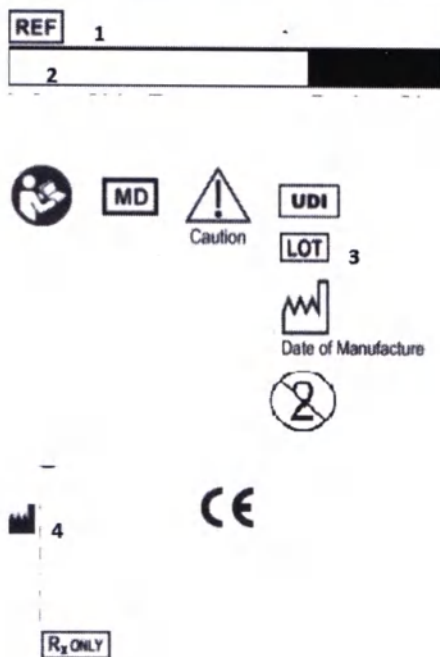


1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Серийный номер
4	Производитель

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Камеры
увлажнения для
воды

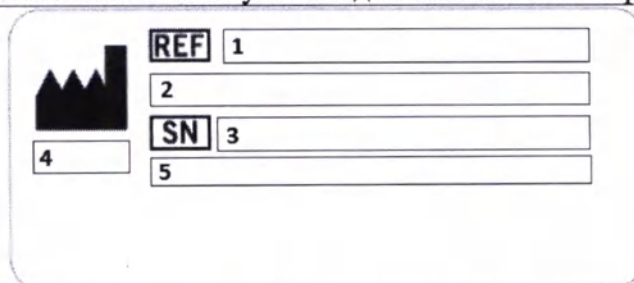


1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Серийный номер
4	Наименование производителя и/или адрес производителя
5	Страна производства

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Флоуметры (для регулировки подачи кислорода)	 REF 1 2 SN 3 5 <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Каталожный номер</td></tr> <tr><td>2</td><td>Наименование изделия</td></tr> <tr><td>3</td><td>Серийный номер</td></tr> <tr><td>4</td><td>Наименование производителя и/или адрес производителя</td></tr> <tr><td>5</td><td>Страна производства</td></tr> </table> Примечание: На маркировке также может быть указана дополнительная информация	1	Каталожный номер	2	Наименование изделия	3	Серийный номер	4	Наименование производителя и/или адрес производителя	5	Страна производства
1	Каталожный номер										
2	Наименование изделия										
3	Серийный номер										
4	Наименование производителя и/или адрес производителя										
5	Страна производства										
Т-образный контур одноразовый	Rx Only CE 1639 Do Not Use If Packaging Is Damaged Product Not Made With Phthalate DEHP <10Kg REF 1 LOT 2 3 4 QTY 20 CH REP Flexicare Medical Switzerland GmbH c/o BK-Services AG Saurestoff 22, 6343 Rotkreuz Switzerland EC REP Flexicare Deutschland GmbH Ohlenhohnstrasse 34 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Germany  (01)15055788776663(17)270601(10)012345678 <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Каталожный номер</td></tr> <tr><td>2</td><td>Серийный номер</td></tr> <tr><td>3</td><td>Срок годности</td></tr> <tr><td>4</td><td>Наименование изделия</td></tr> <tr><td>5</td><td>производитель</td></tr> </table> Примечание: На маркировке также может быть указана дополнительная информация	1	Каталожный номер	2	Серийный номер	3	Срок годности	4	Наименование изделия	5	производитель
1	Каталожный номер										
2	Серийный номер										
3	Срок годности										
4	Наименование изделия										
5	производитель										
Т-образный контур, одноразовый, с маской, неонатальный											

	           REF 1 LOT 2 3 4 QTY 20  (01)15055788776663(17)270601(10)012345678 CH REP 5 Flexicare Medical Switzerland GmbH c/o BK-Services AG Saurstoffli 22, 6343 Rotkreuz Switzerland EC REP Flexicare Deutschland GmbH Ohlenhohnstrasse 34 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Germany
Т-образный контур одноразовый, с маской, для младенцев	           REF 1 LOT 2 3 4 QTY 20  (01)15055788776663(17)270601(10)012345678 CH REP 5 Flexicare Medical Switzerland GmbH c/o BK-Services AG Saurstoffli 22, 6343 Rotkreuz Switzerland EC REP Flexicare Deutschland GmbH Ohlenhohnstrasse 34 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Germany
Дверцы инкубатора	



1

2

REF

3



SN


4

5

1	Наименование производителя и/или адрес производителя
2	Наименование изделия
3	Каталожный номер
4	Серийный номер
5	Страна производства

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

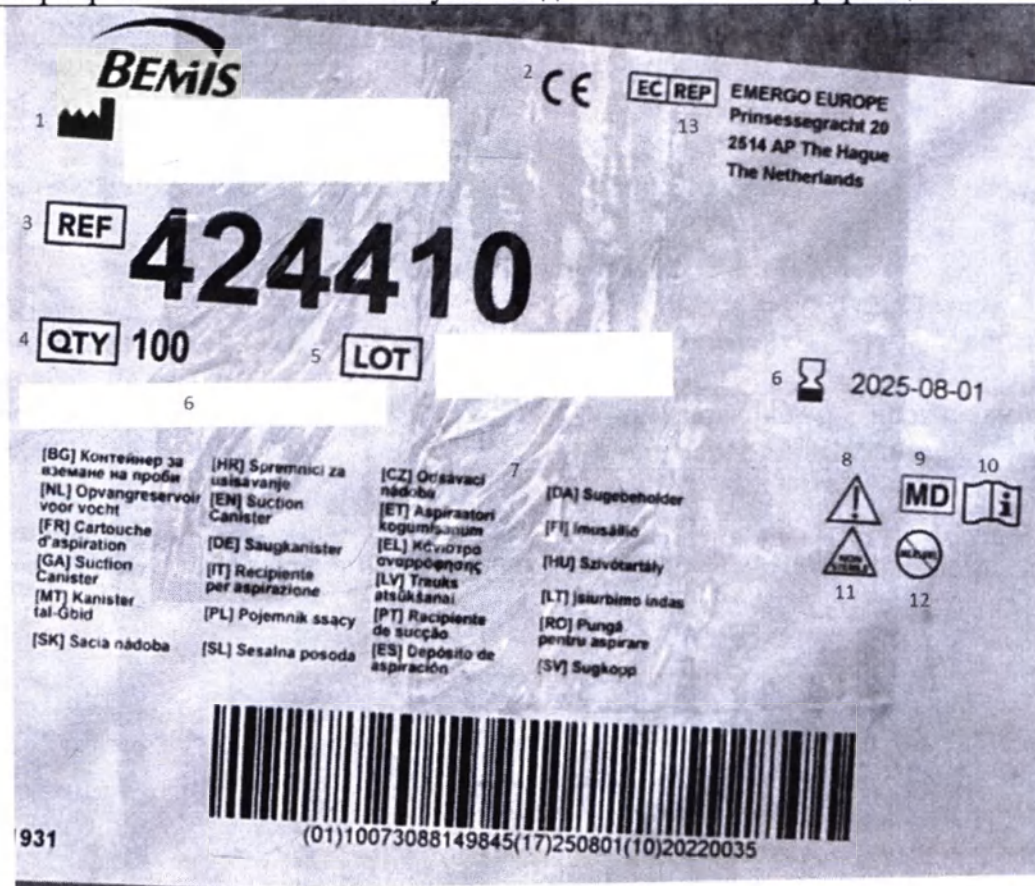Емкости для
аспираторов


1	Наименование производителя и/или адрес производителя	8	Осторожно!Обратитесь к инструкции по применению
2	Знак CE	9	Медицинское изделие
3	Каталожный номер	10	Обратитесь к инструкции по применению

4	Количество штук в упаковке	1 1	Не стерильно
5	Номер партии	1 2	Не подлежит повторному использованию
6	Использовать до	1 3	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
7	Наименование изделия на разных языках		

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Корзина для принадлежности с креплением «ласточкин хвост»

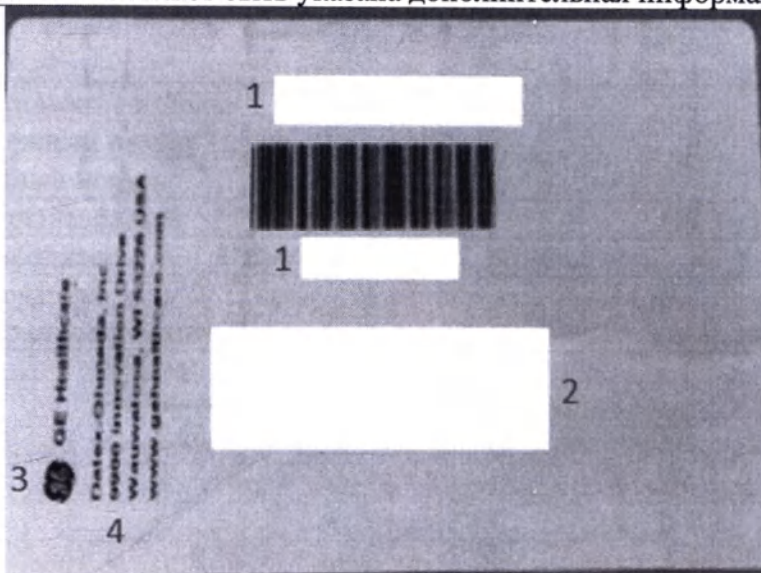


1	Каталожный номер	3	Наименование и логотип компании
2	Наименование изделия	4	Наименование производителя и/или адрес производителя

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Лампы экзаменационные, варианты исполнения: Светодиодные с подключением к аппарату, IEC

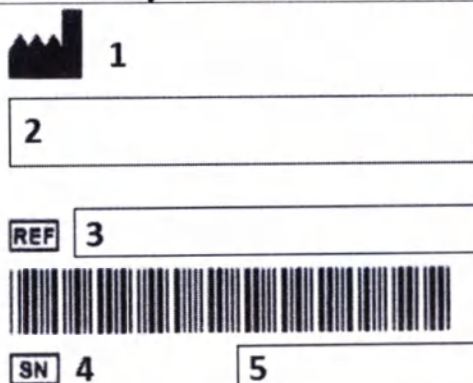

1	Наименование производителя и/или адрес производителя
2	Наименование изделия
3	Каталожный номер
4	Серийный номер

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">5</td> <td>Страна производства</td> </tr> </table> Примечание: На маркировке также может быть указана дополнительная информация	5	Страна производства										
5	Страна производства												
Матрасики с распределением веса тела	1 REF 2 CE i ! LOT 3 4 5 UDI MD R ONLY EC REP GE Medical Systems SCS 283 Rue de la Minière 78530 BUC, France <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%; text-align: center;">1</td><td>Наименование изделия</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Каталожный номер</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Серийный номер</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Дата производства</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Производитель</td></tr> <tr> <td></td> <td>Примечание: На маркировке также может быть указана дополнительная информация</td> </tr> </table>	1	Наименование изделия	2	Каталожный номер	3	Серийный номер	4	Дата производства	5	Производитель		Примечание: На маркировке также может быть указана дополнительная информация
1	Наименование изделия												
2	Каталожный номер												
3	Серийный номер												
4	Дата производства												
5	Производитель												
	Примечание: На маркировке также может быть указана дополнительная информация												
Чехлы защитные для матрасика с распределением веса тела	REF 1 x1 2 LOT 3 4 Date of Manufacture Manufactured for 5 4 ! Caution X For Single Use Only CE ! X !												

	Примечание: На маркировке также может быть указана дополнительная информация										
Стойки инфузионные, варианты исполнения: Вращающийся штатив для внутривенных вливаний	1 REF 2   MD 3 EC REP GE Medical Systems SCS 283 Rue de la Minière 78530 BUC - FRANCE LOT 4 5   0% 85%  50kPa 375mmHg 106kPa 795mmHg  -25°C -13°F +60°C +140°F 5842635 Rev 2 <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Наименование изделия</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Каталожный номер</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Производитель</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Серийный номер</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Дата производства</td></tr> </table> Примечание: На маркировке также может быть указана дополнительная информация	1	Наименование изделия	2	Каталожный номер	3	Производитель	4	Серийный номер	5	Дата производства
1	Наименование изделия										
2	Каталожный номер										
3	Производитель										
4	Серийный номер										
5	Дата производства										

Стойки
инфузионные,
варианты
исполнения:
Штатив для
внутривенных
вливаний в сборе

1
REF 2



3

EC REP



GE Medical Systems SCS
283 Rue de la Minière
78530 BUC - FRANCE



4



5



5842635 Rev 2

1	Наименование изделия
2	Каталожный номер
3	Производитель
4	Серийный номер
5	Дата производства

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация



Chin'toora



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента
по регистрации и сертификации
Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
доверенность № 9/22-М от 20.04.2022



Харитонов А.П.

2023г.
М.П.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Реанимационная система для новорожденных Giraffe Omnibed Carestation с
принадлежностями


производства

Datex-Ohmeda, Inc. / "Датекс-Охмеда Инк.", США

1. Реанимационная система для новорожденных Giraffe Omnibed Carestation. Вид спереди

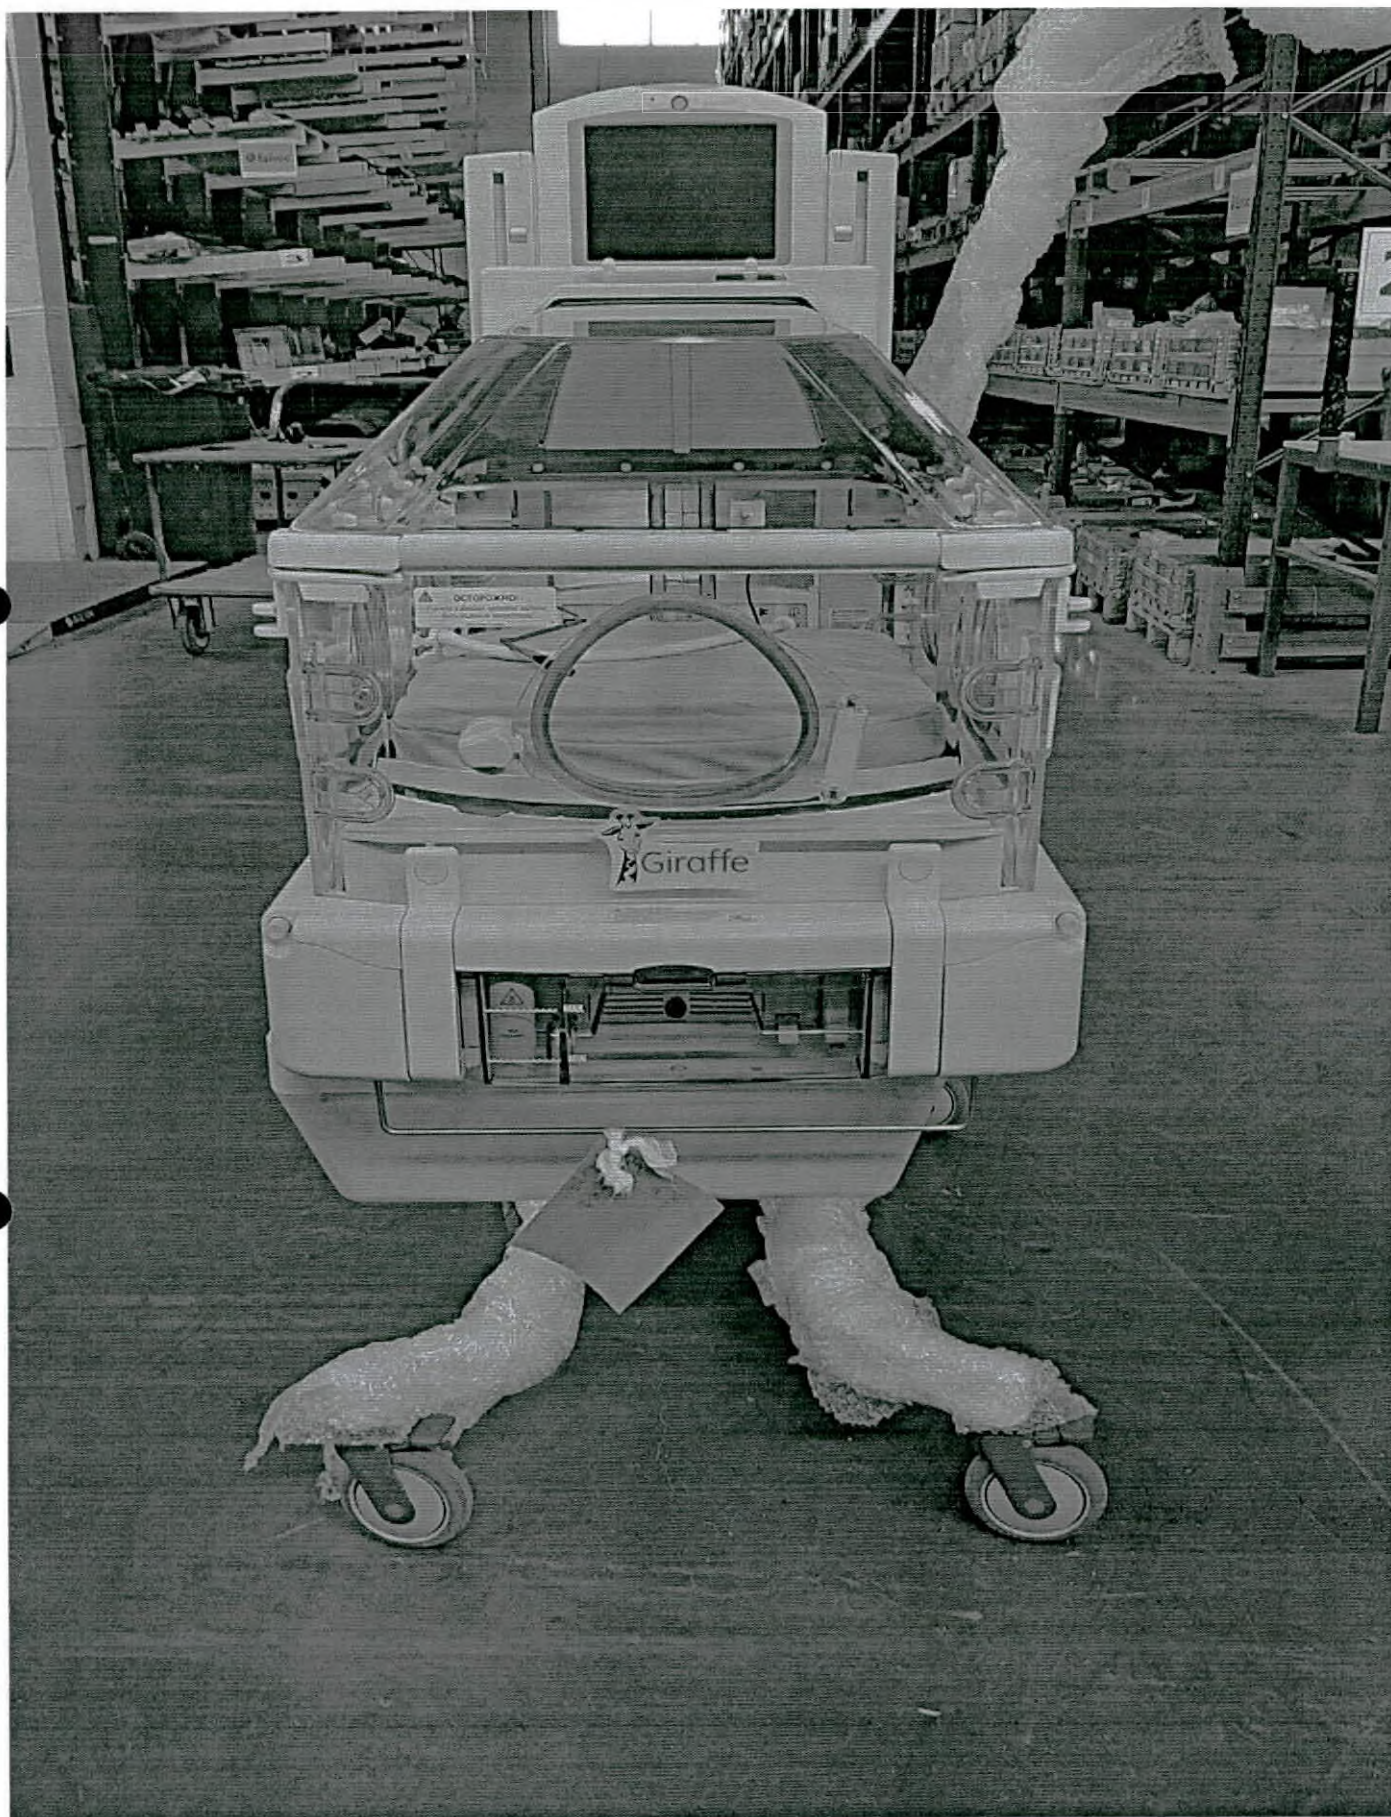

2. Реанимационная система для новорожденных Giraffe Omnibed Carestation.. Вид сбоку

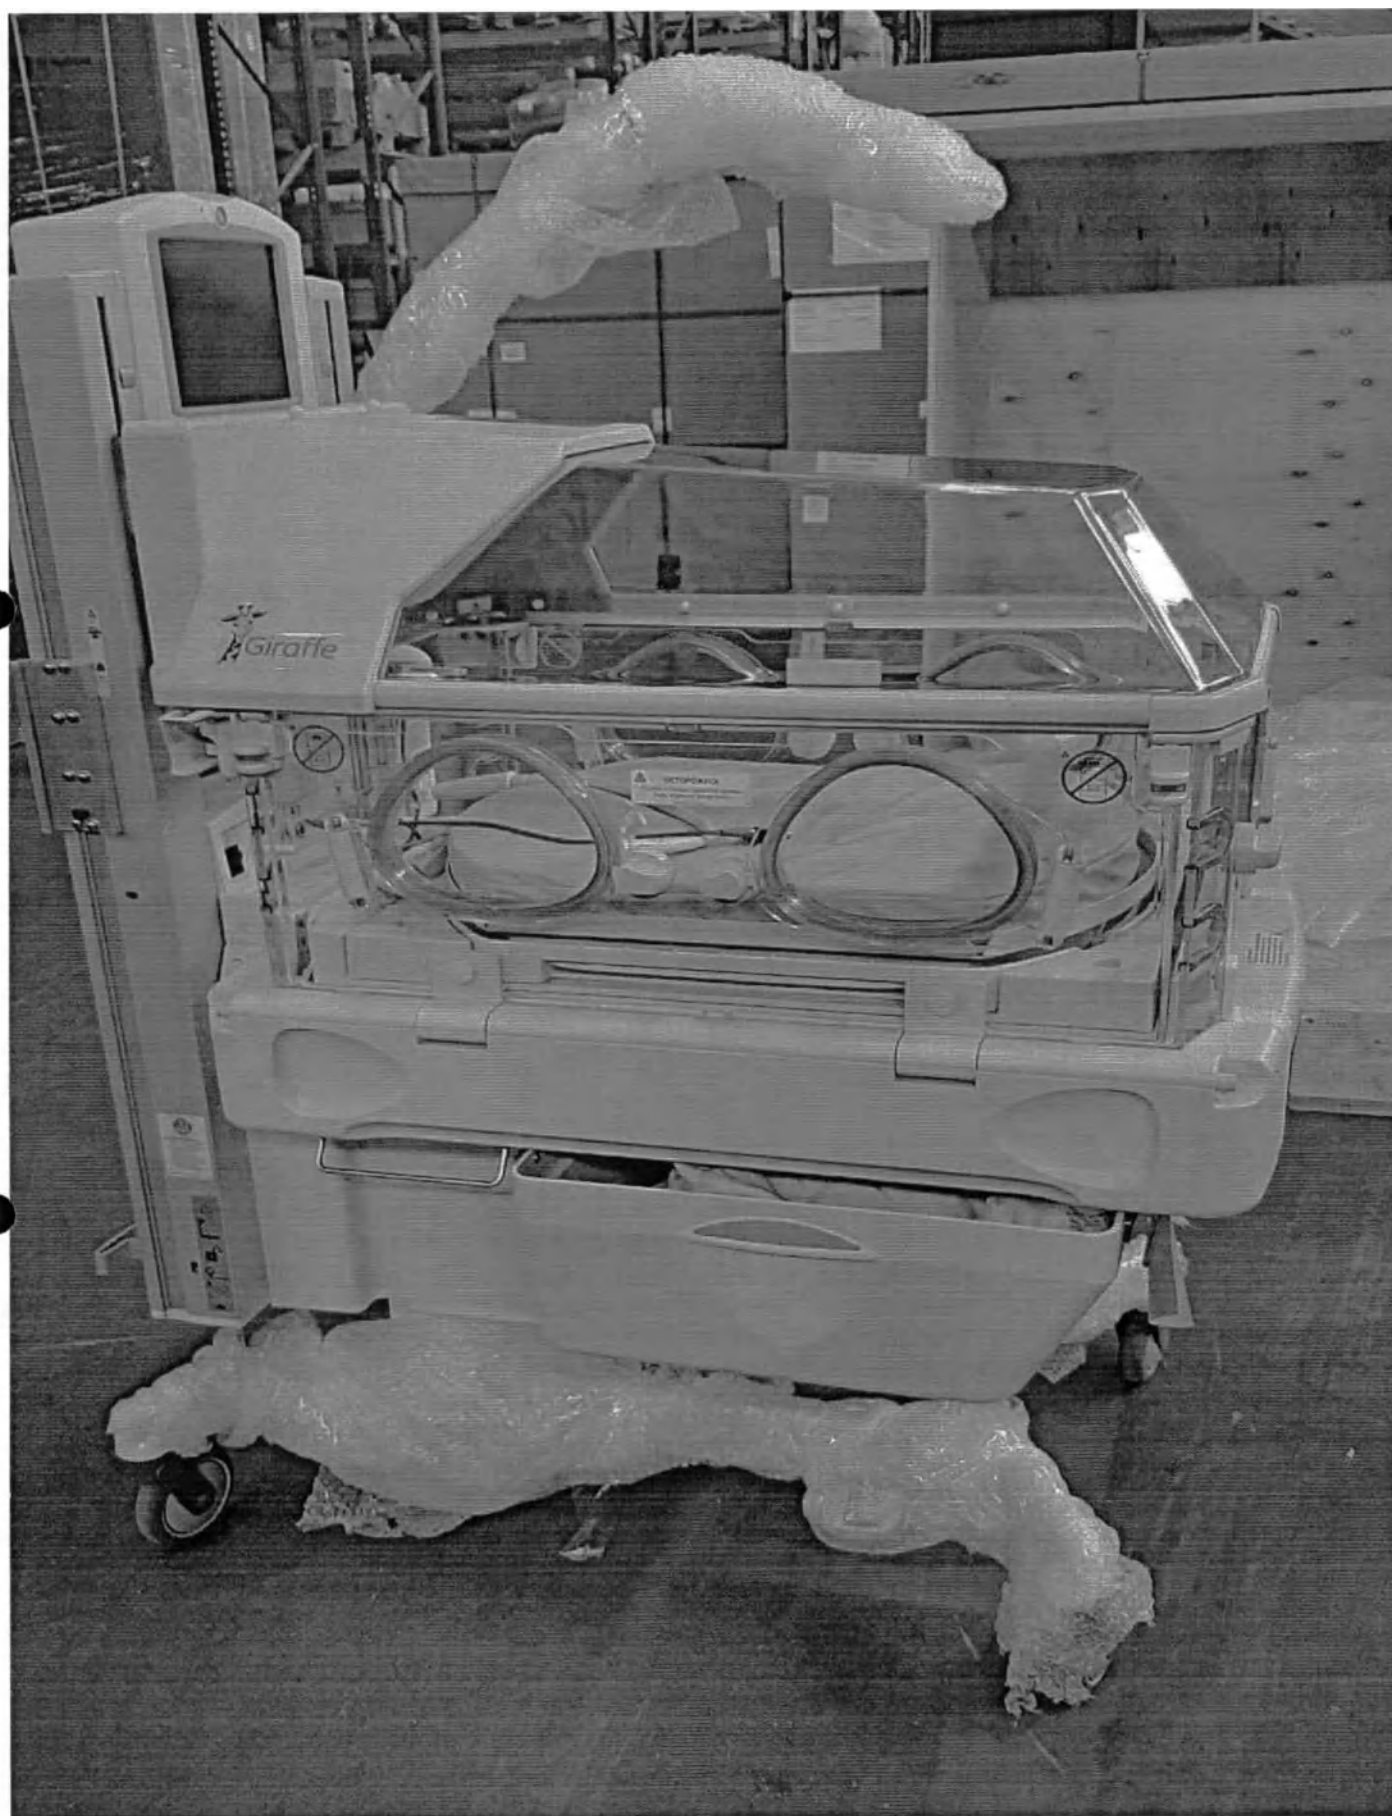

3. Защелки окошек




4. Заделки прикроватных панелей. Незафиксированное положение



5. Защелки прикроватных панелей. Зафиксированное положение




6. Вторичная транспортная упаковка.

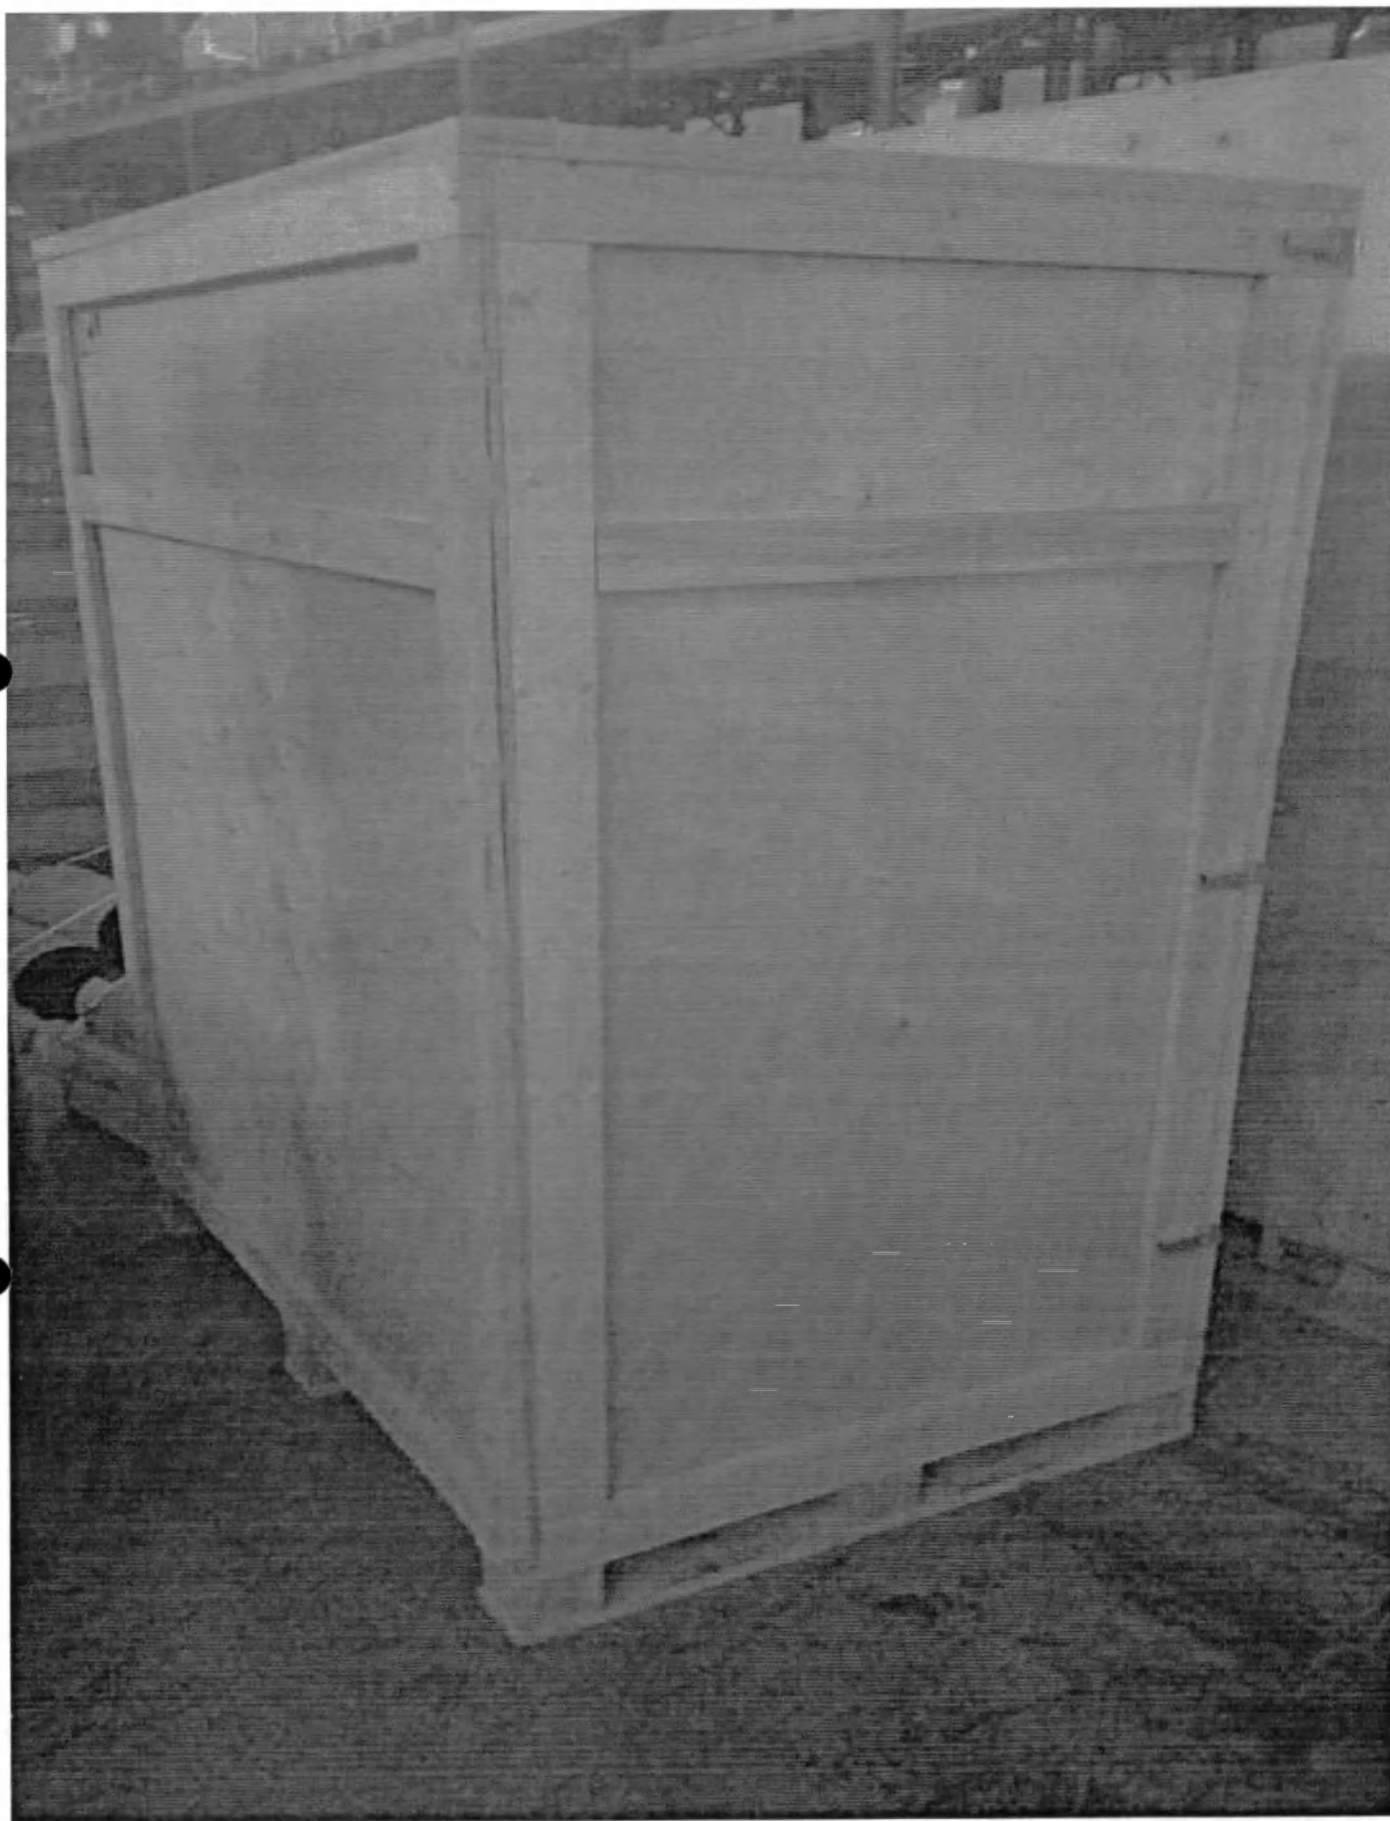

7. Транспортная упаковка (картонная коробка).




8. Маркировка транспортной упаковки (картонная коробка).

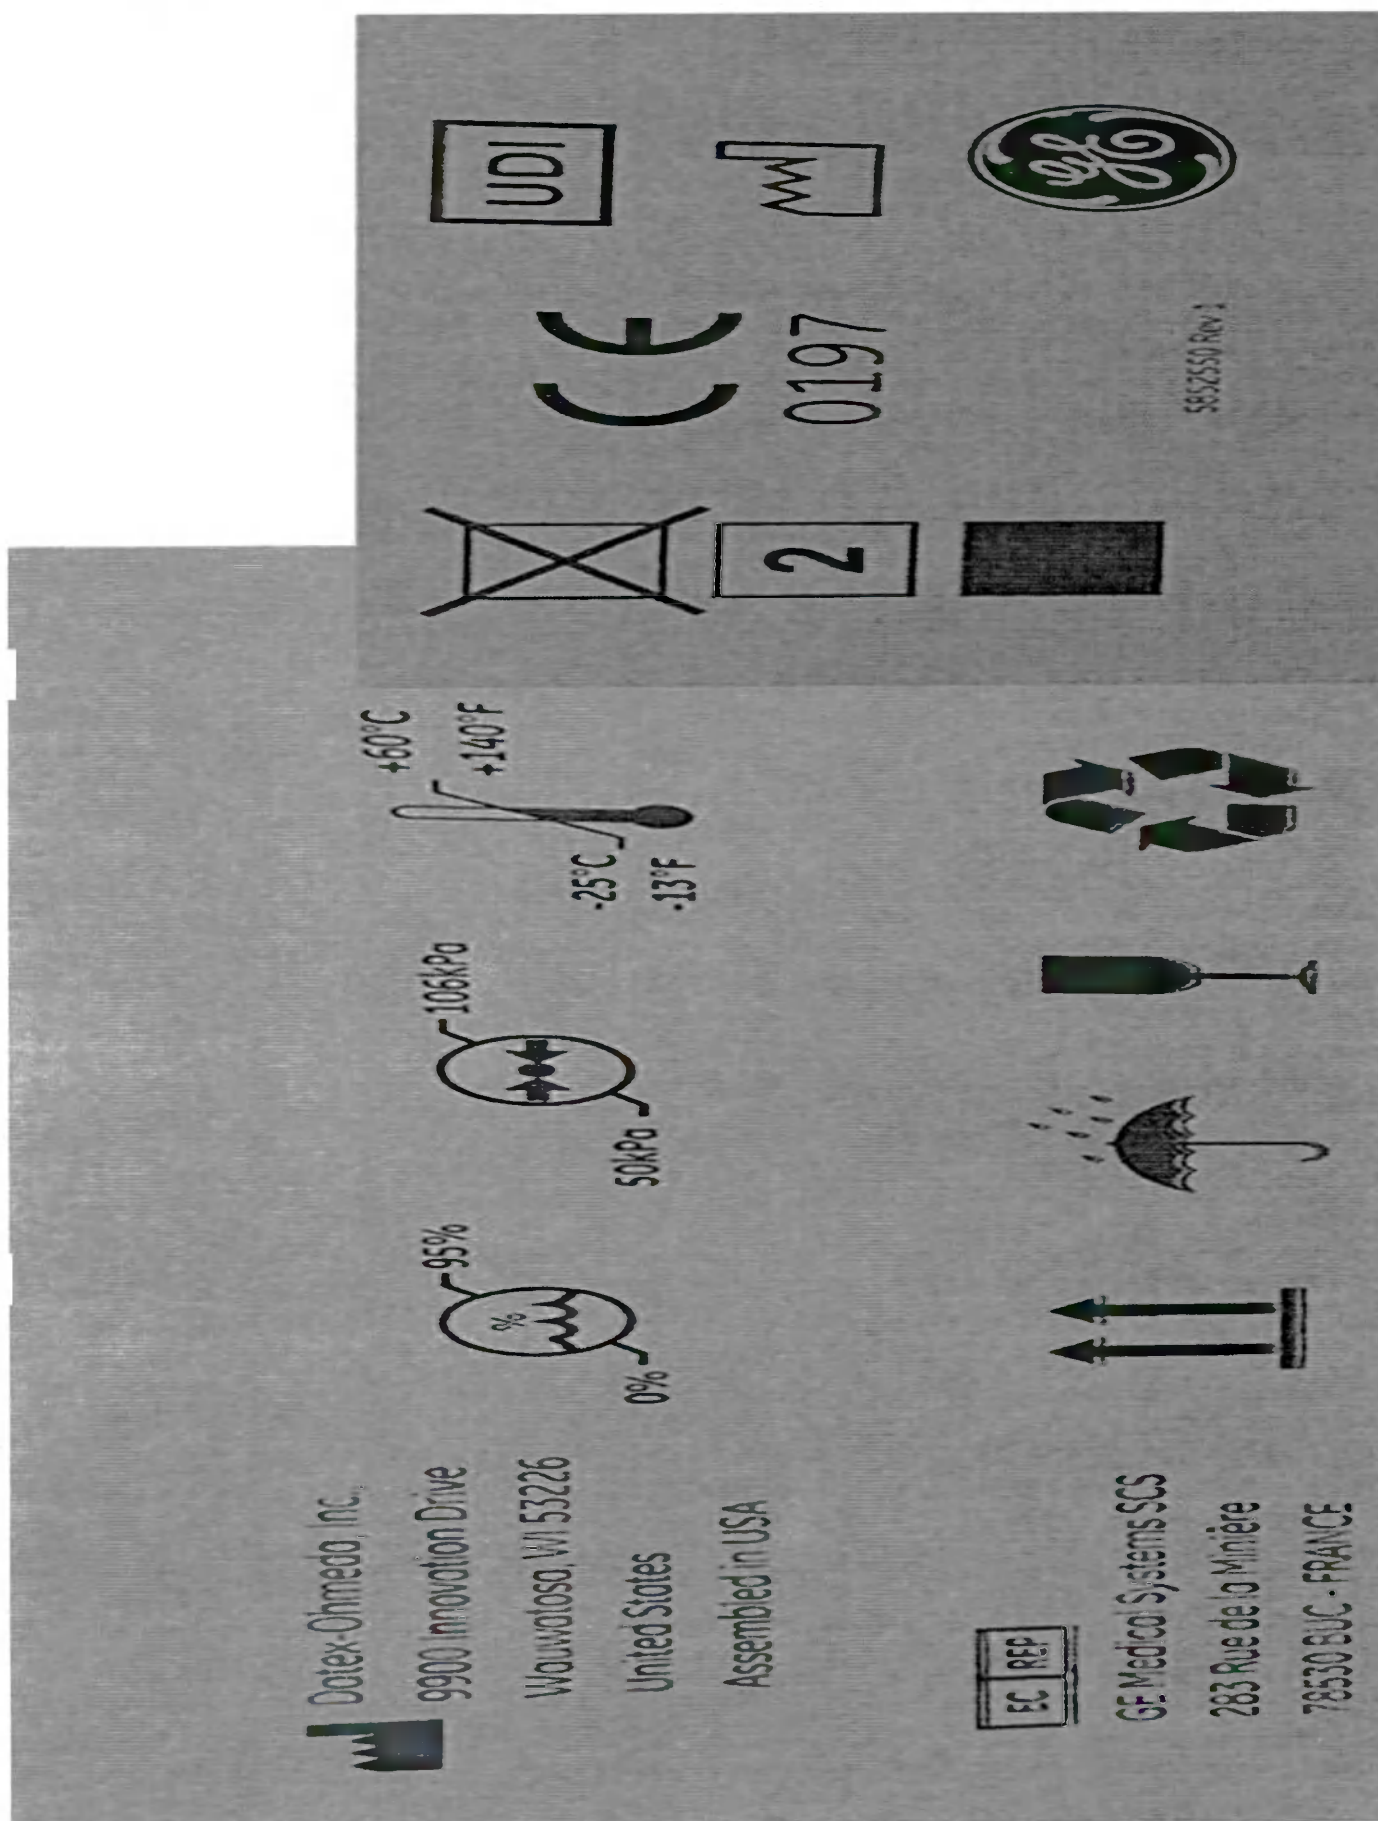





2105492-001 Rev E
Carestation Rating Label Set

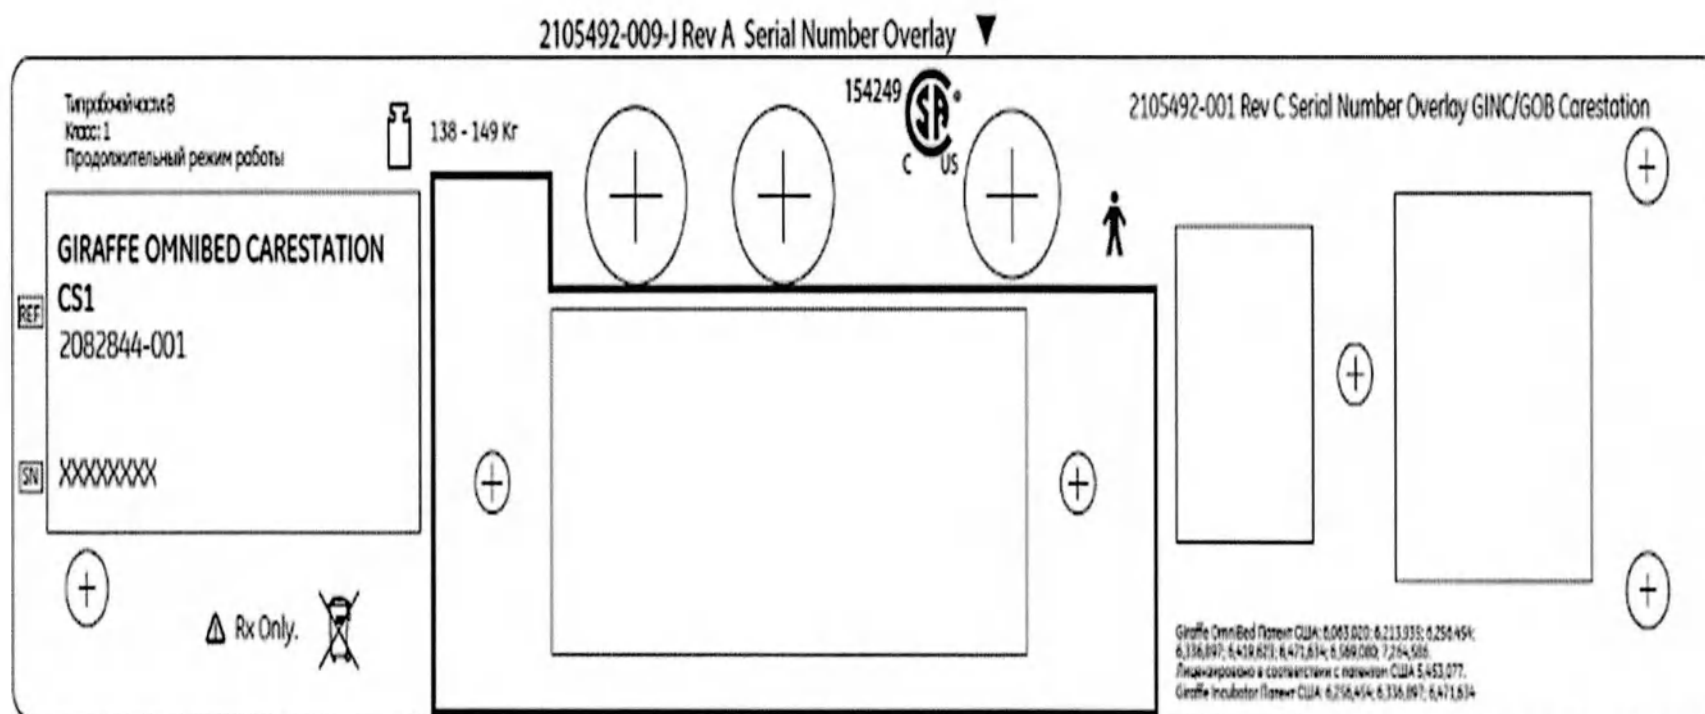


10. Веса электронные встроенные в ложе (при необходимости).

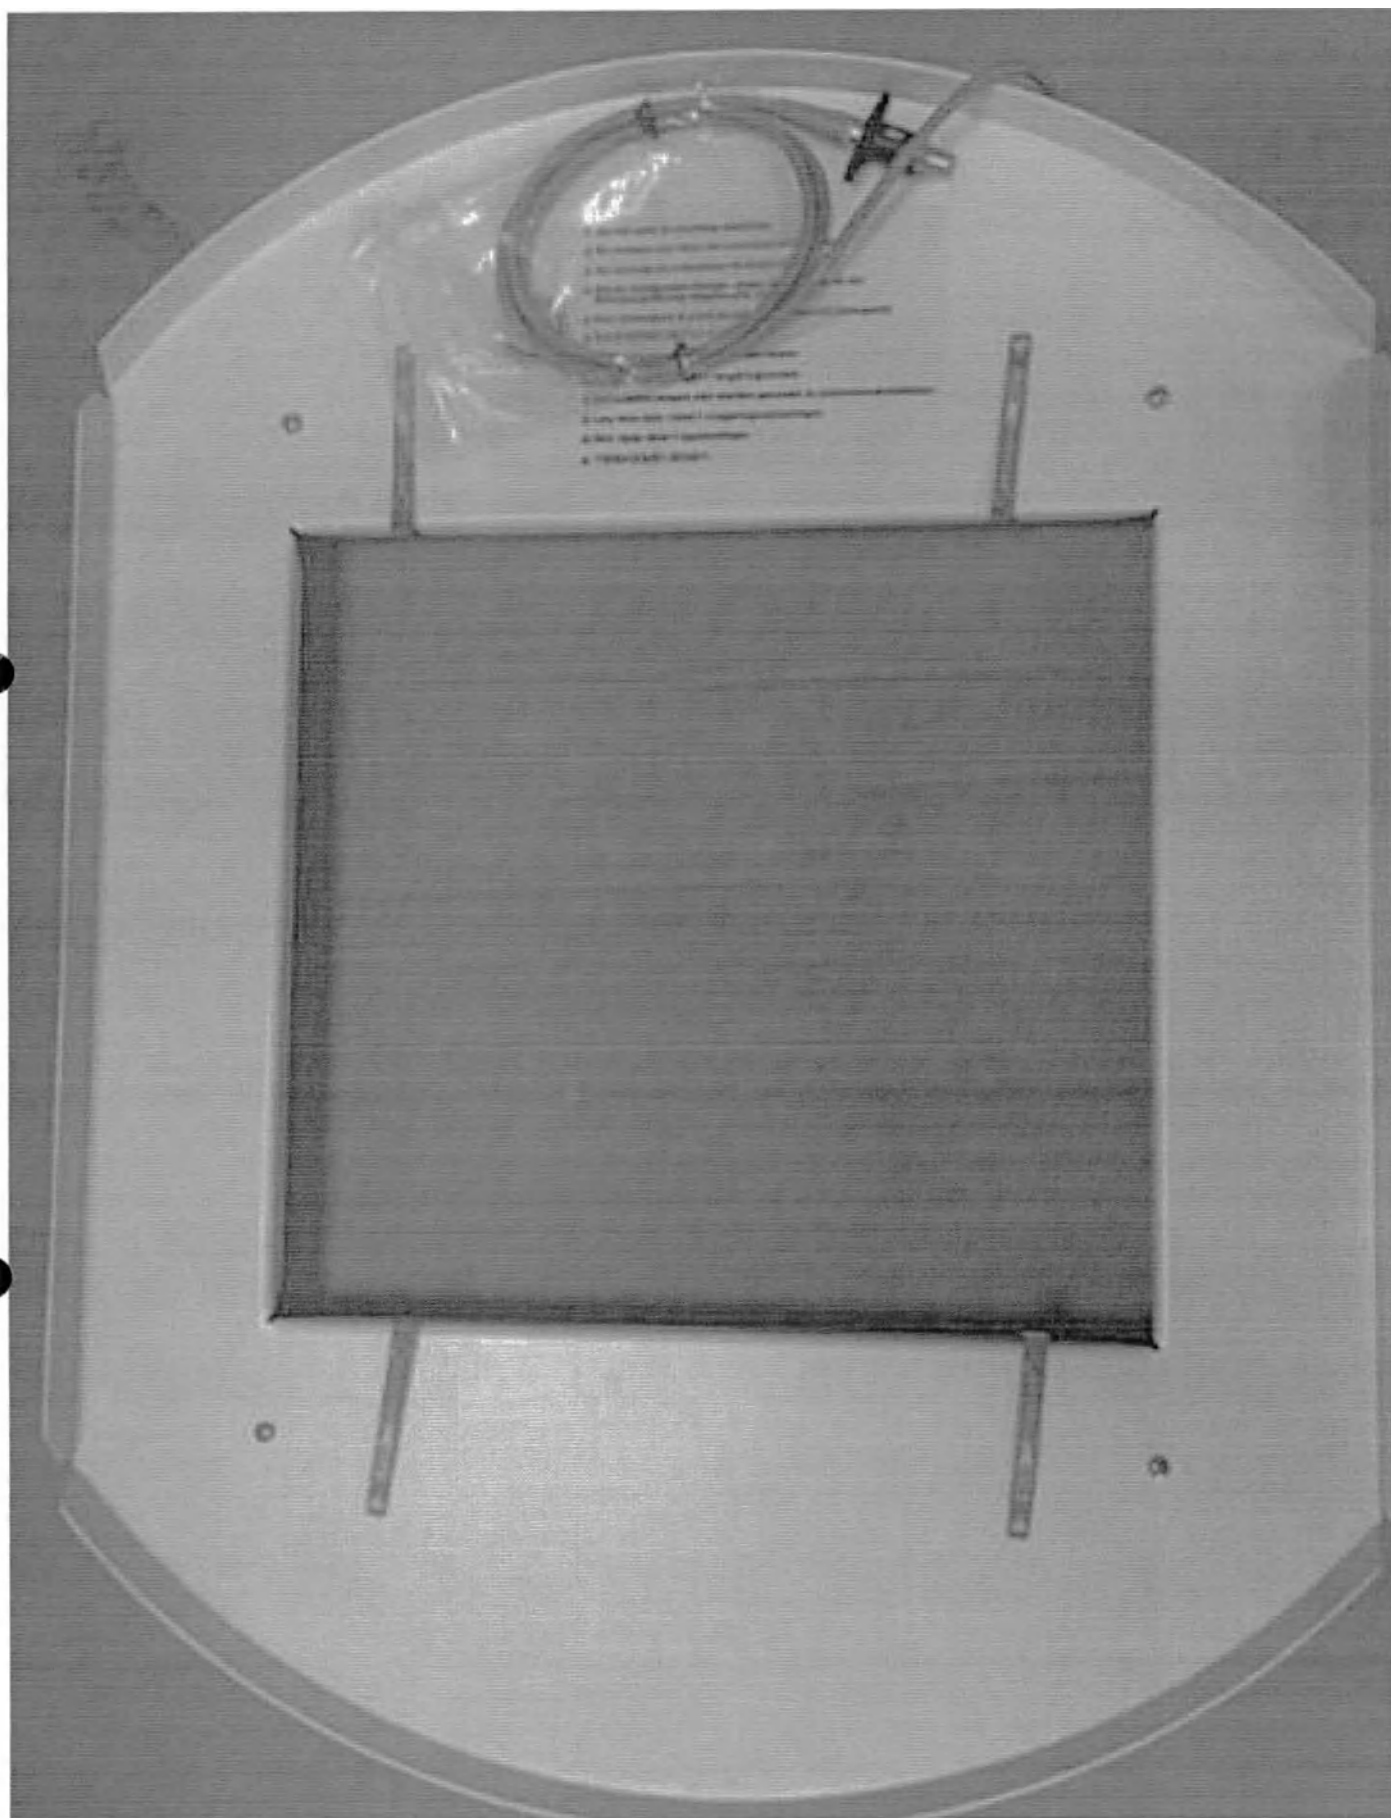



11. Блок газосмесительный с Т-образным контуром (при необходимости).

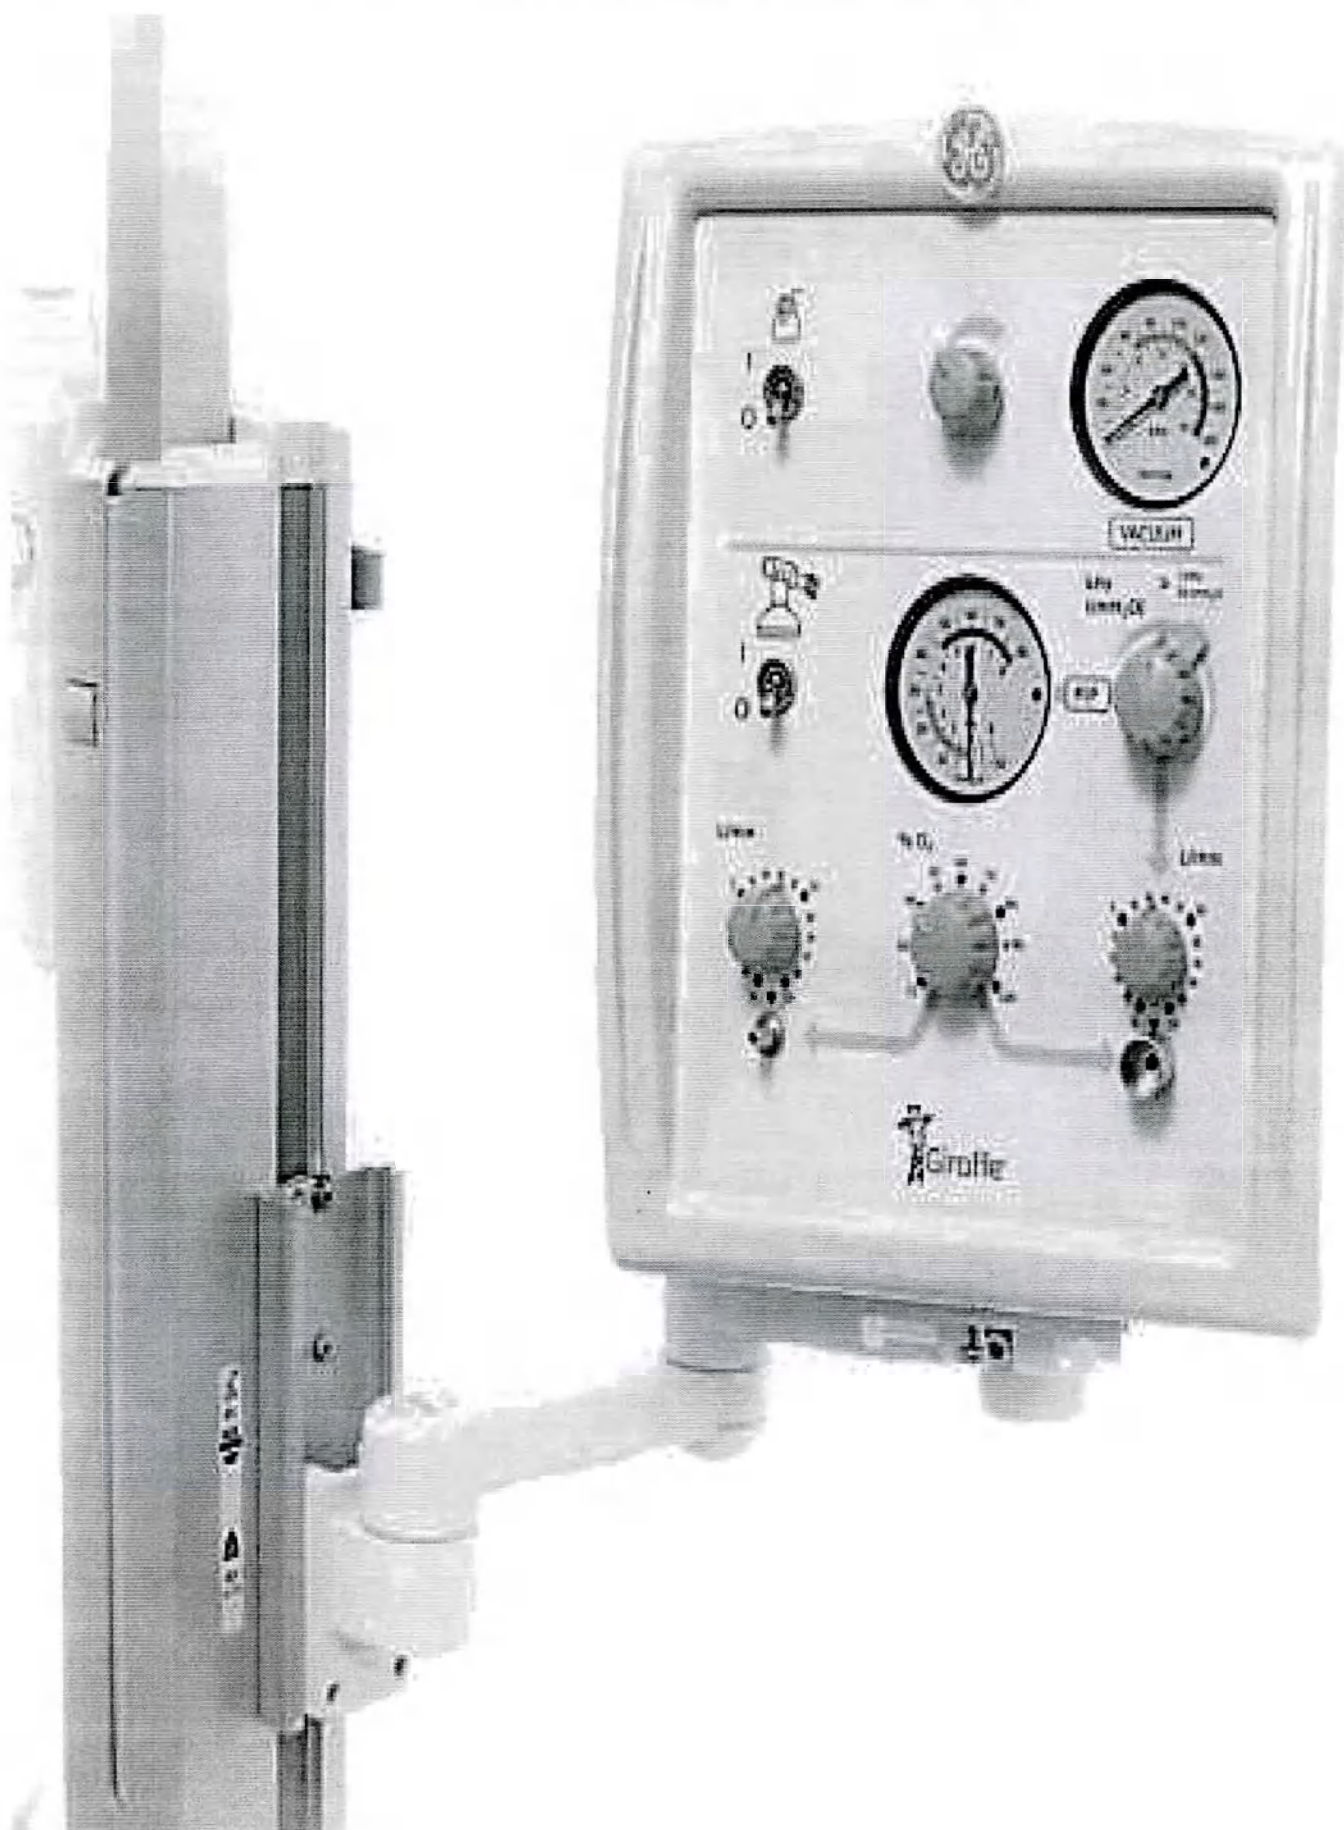

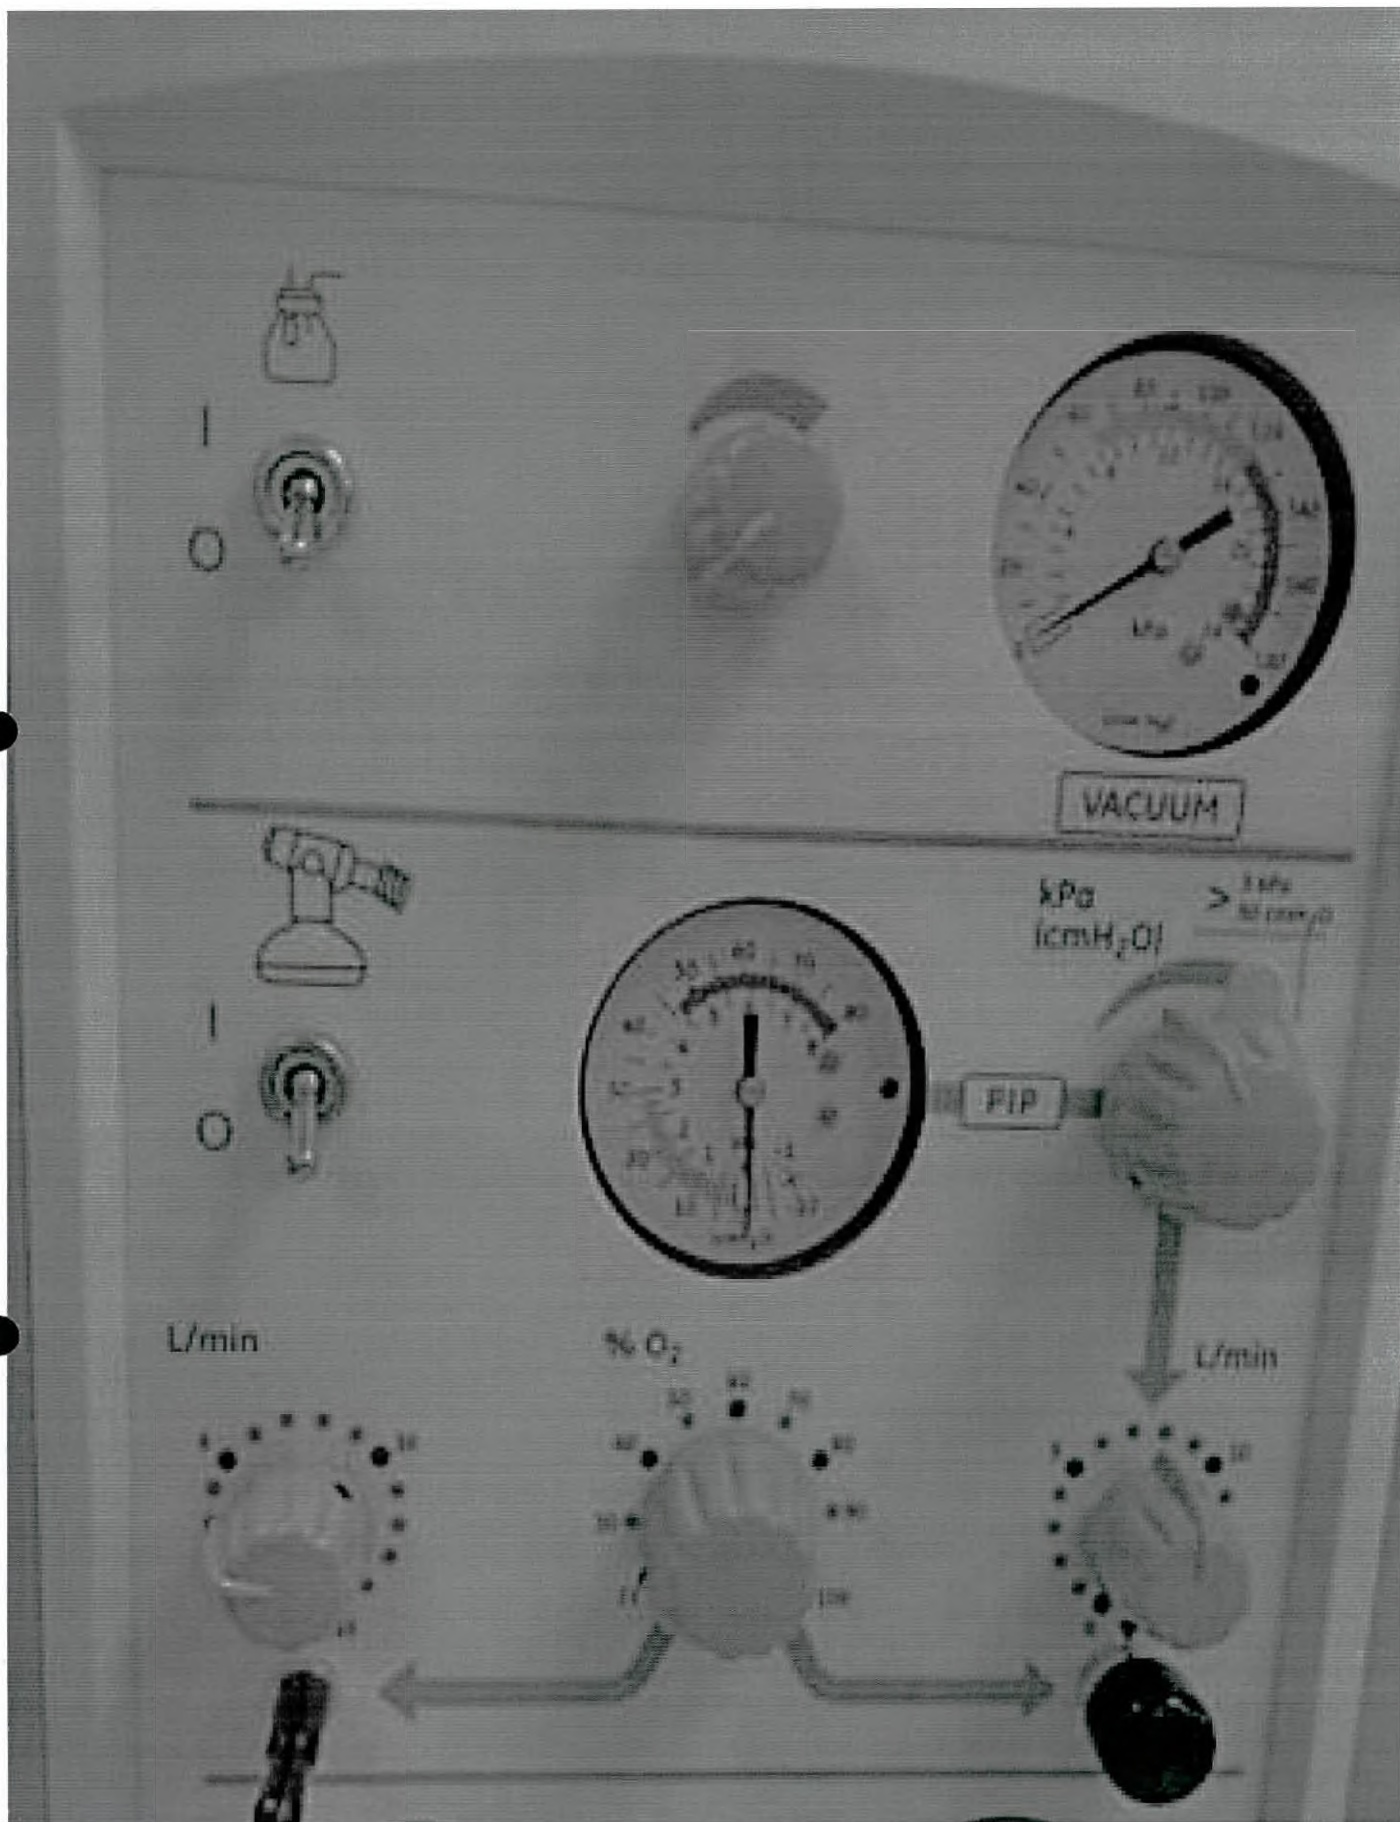



Т-образный контур одноразовый, 20 шт/уп., (не более 50 шт.) (при необходимости).

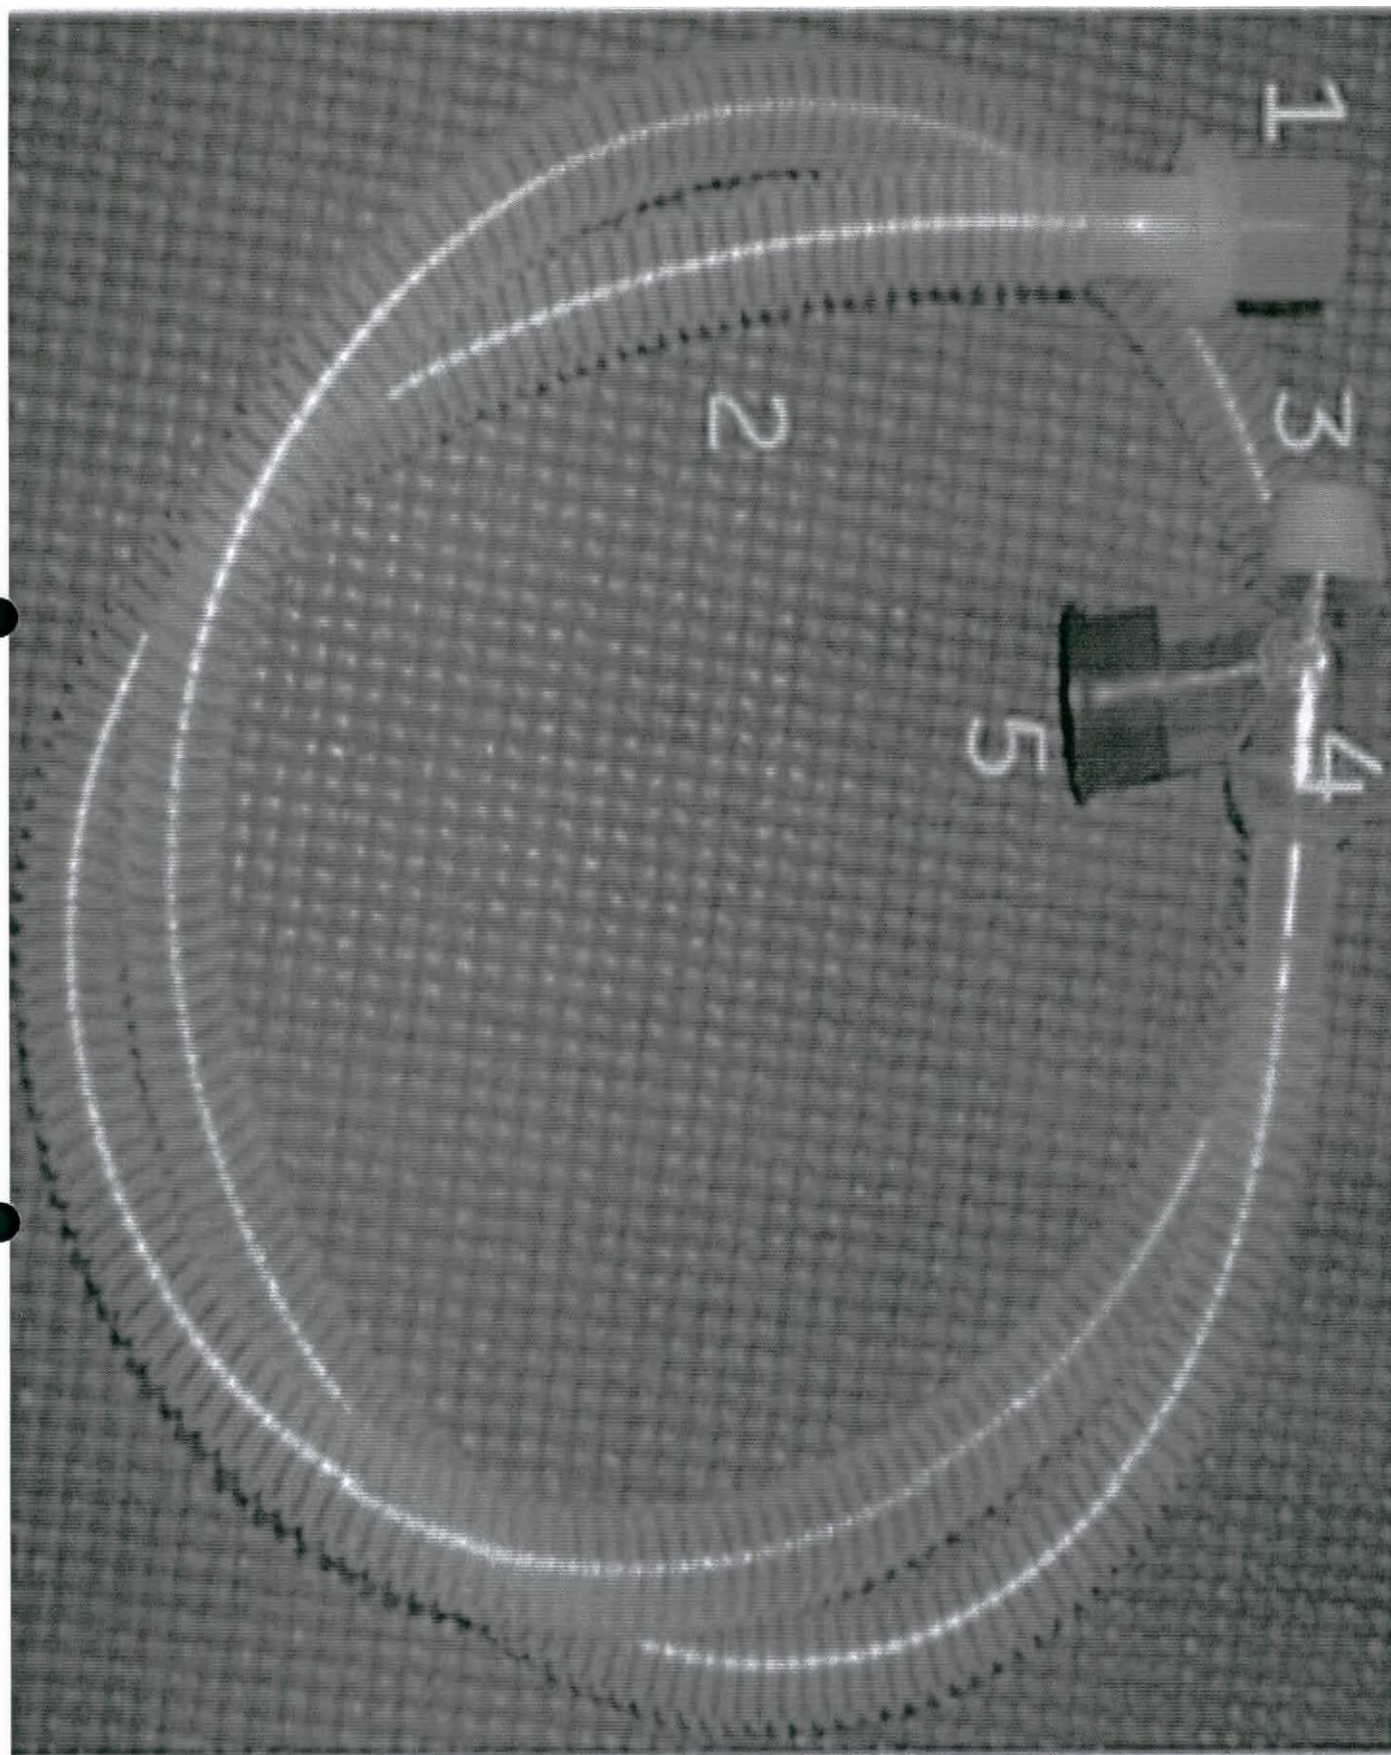

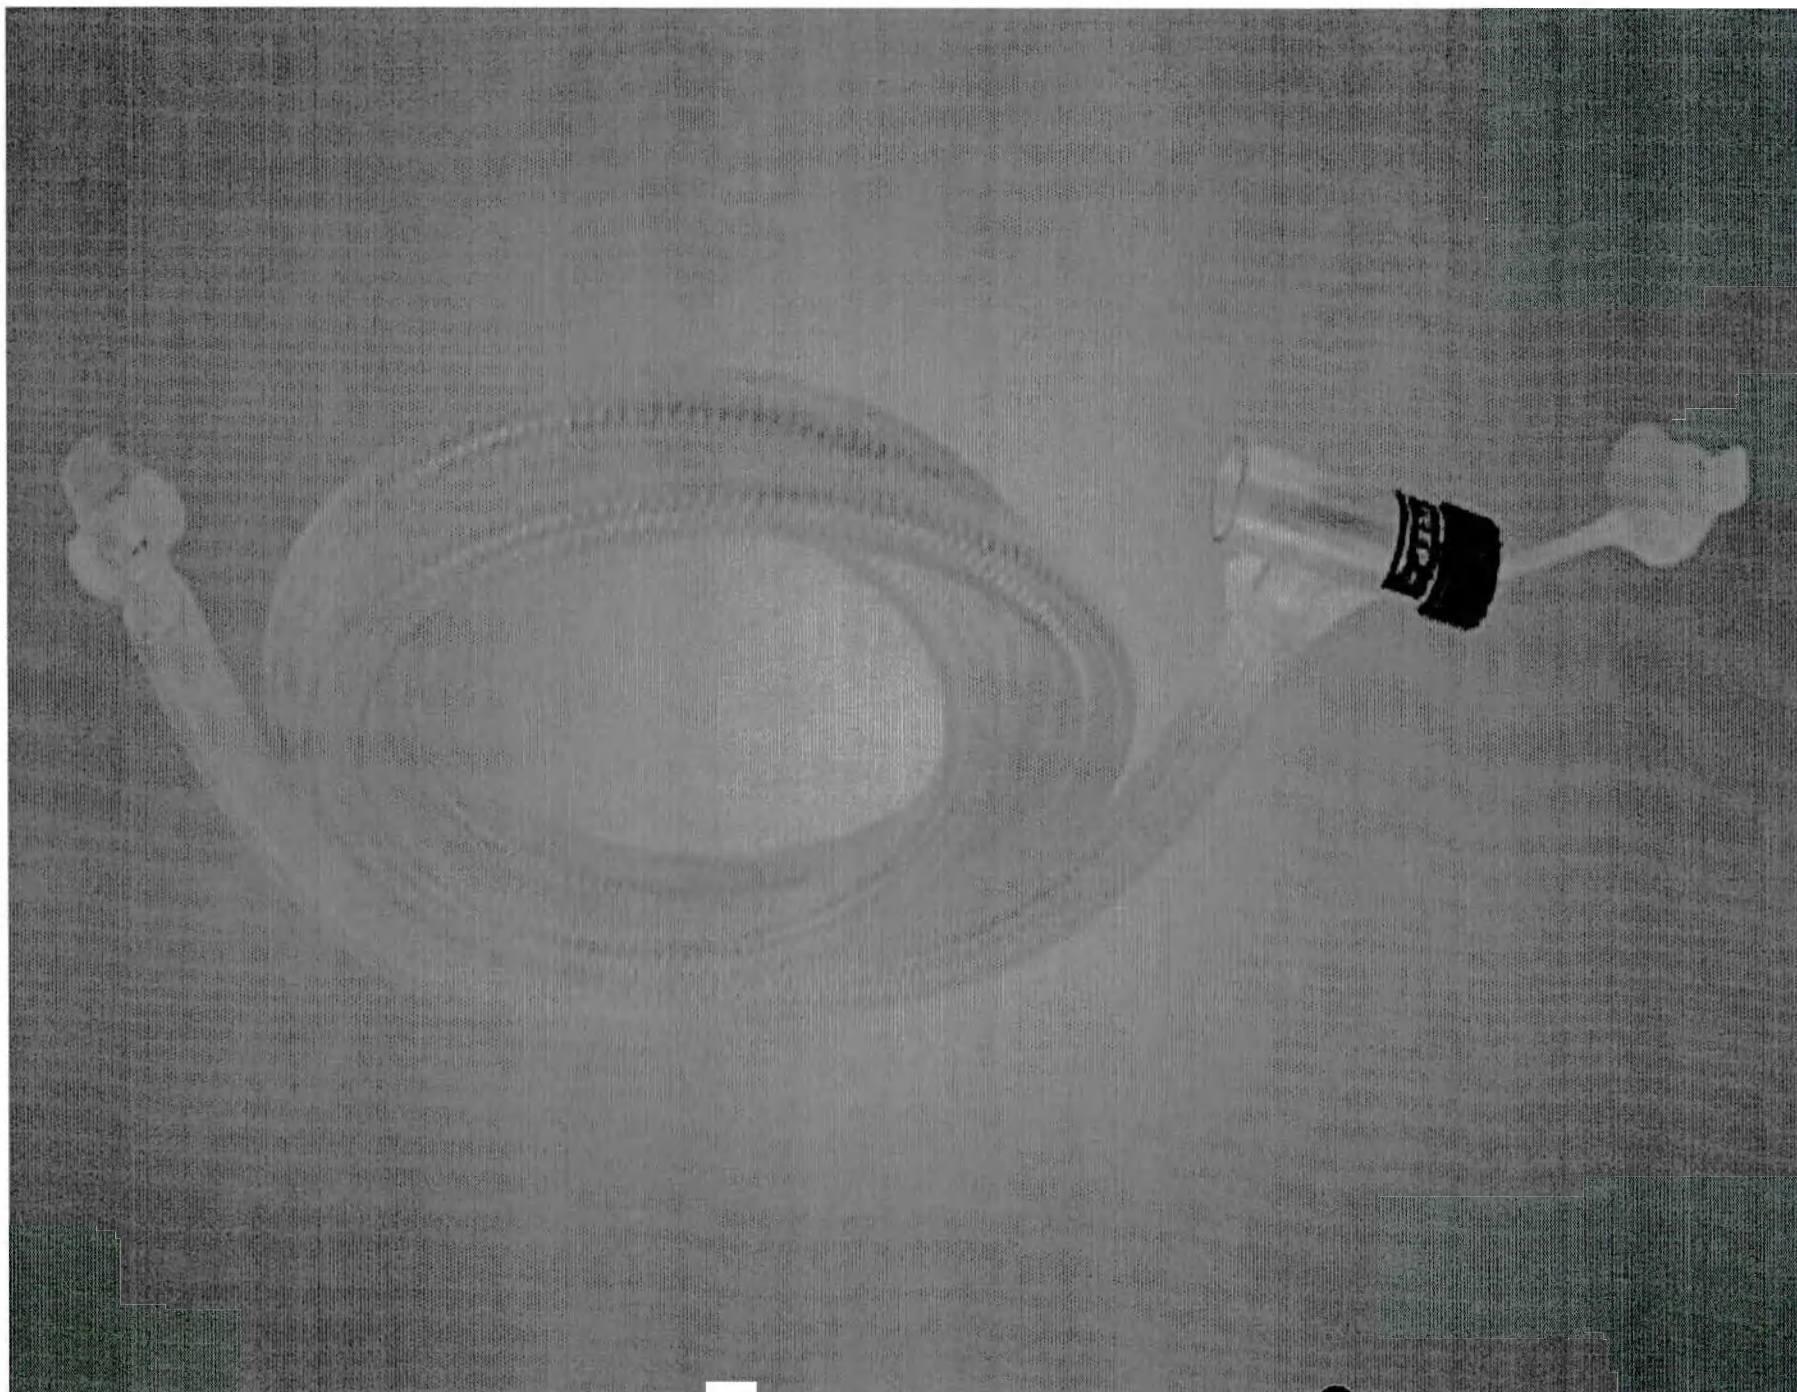


Т-образный контур, одноразовый, с маской, неонатальный, 20 шт/уп, (не более 50 шт.) (при необходимости).

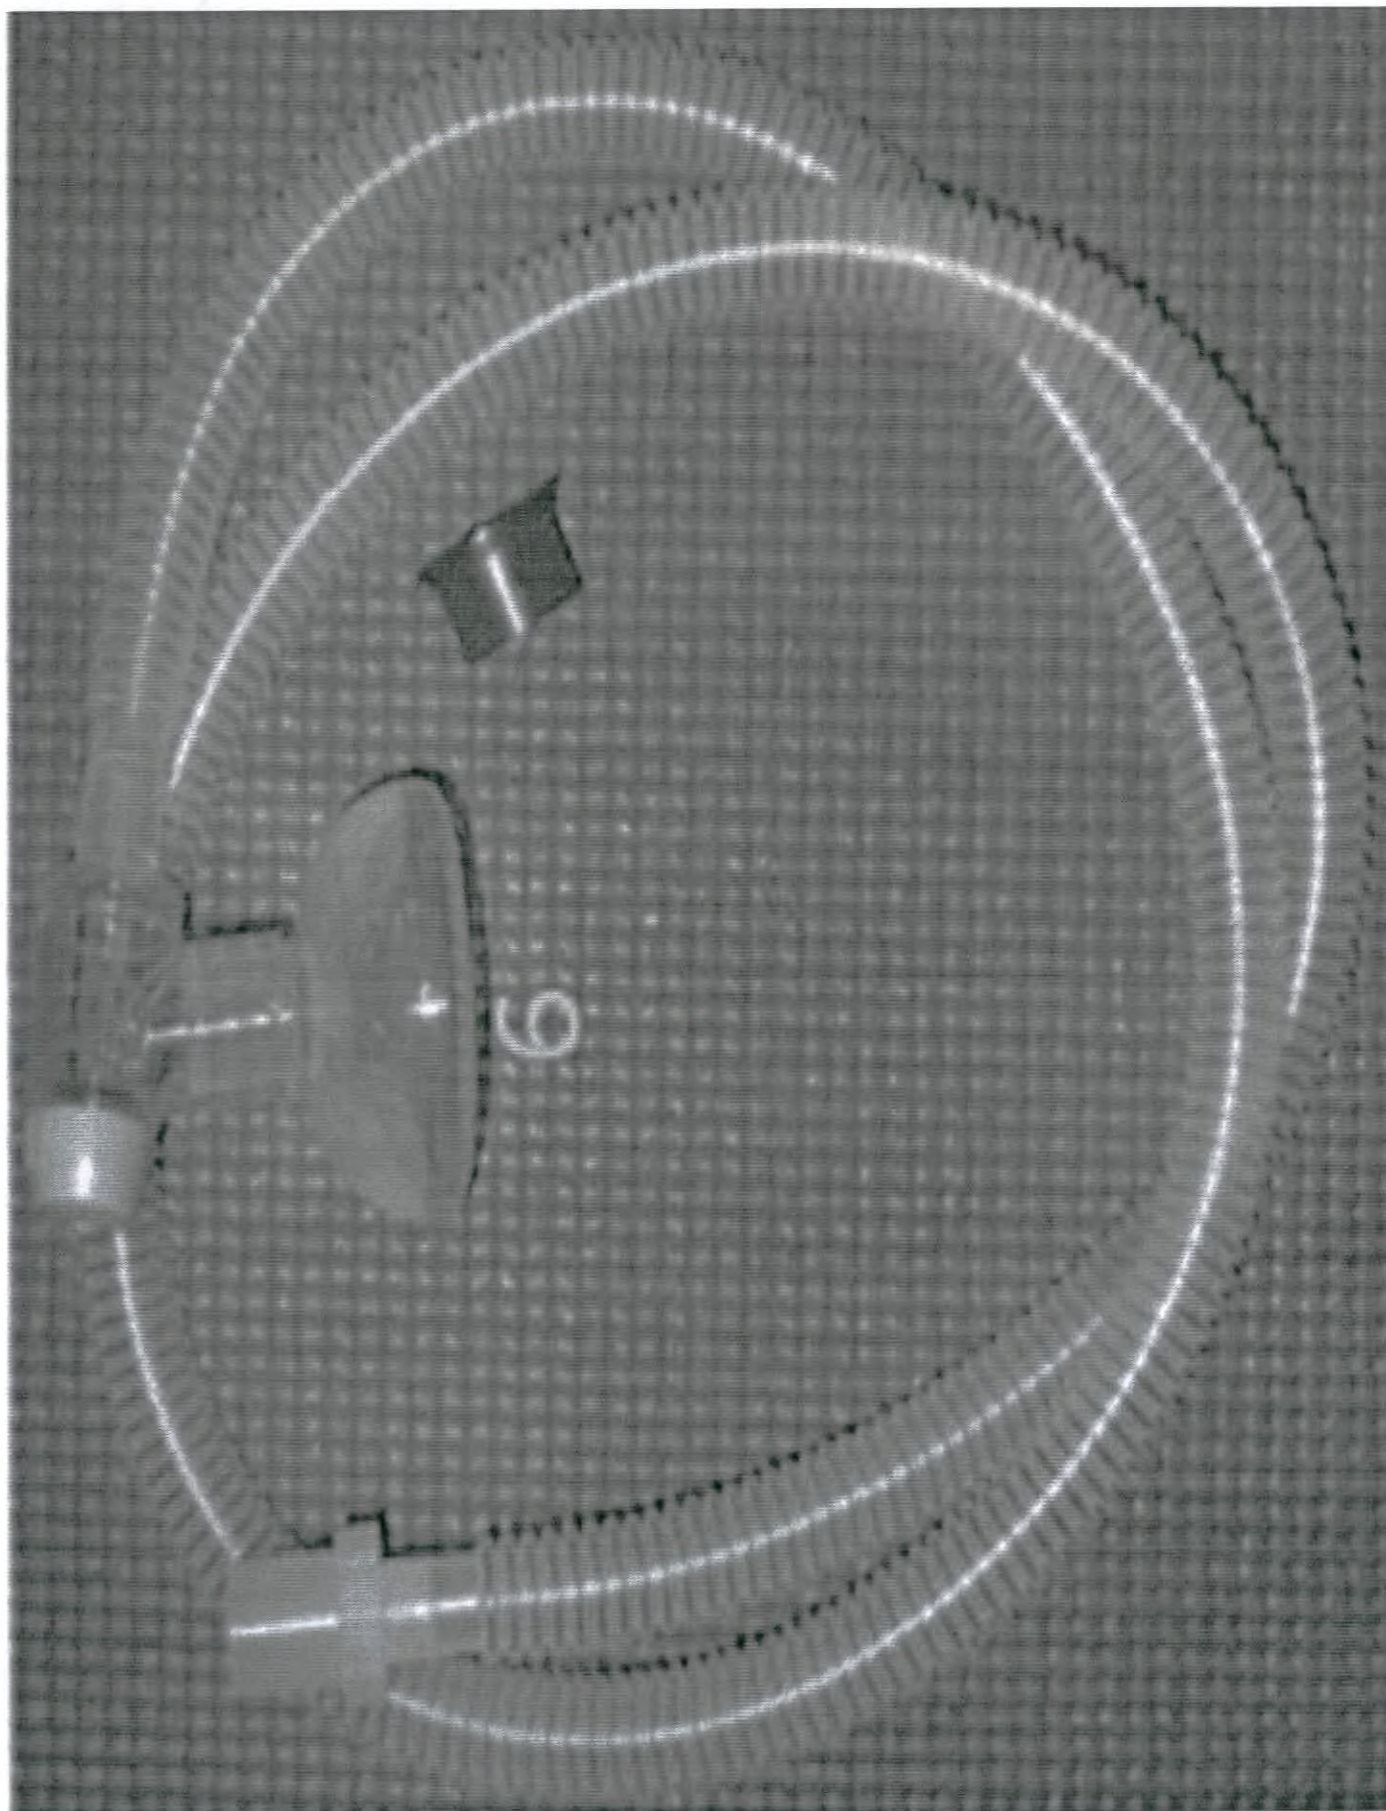

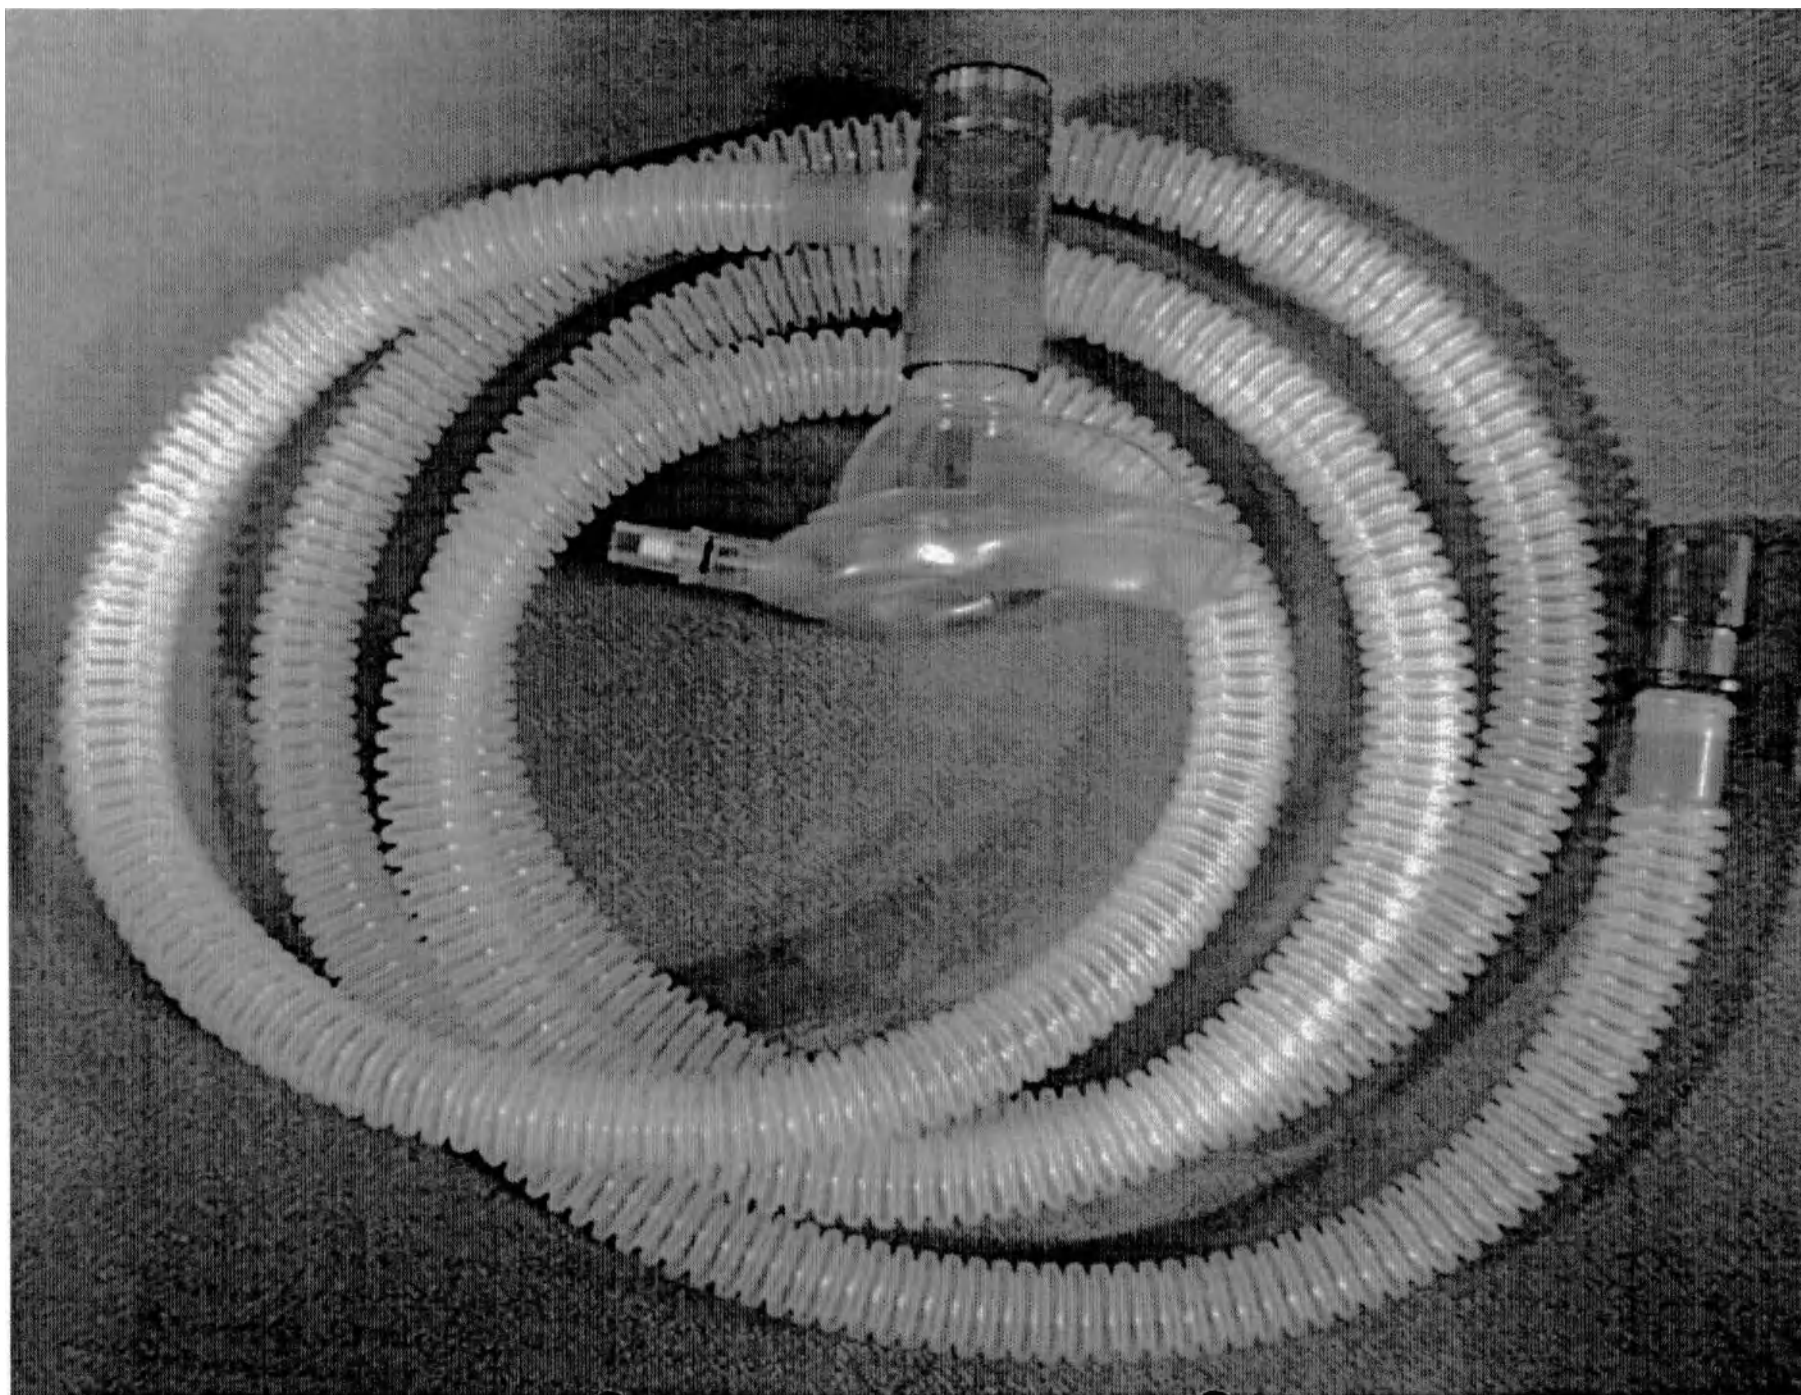


Т-образный контур одноразовый, с маской, для младенцев, 20 шт/уп, (не более 50 шт.) (при необходимости).

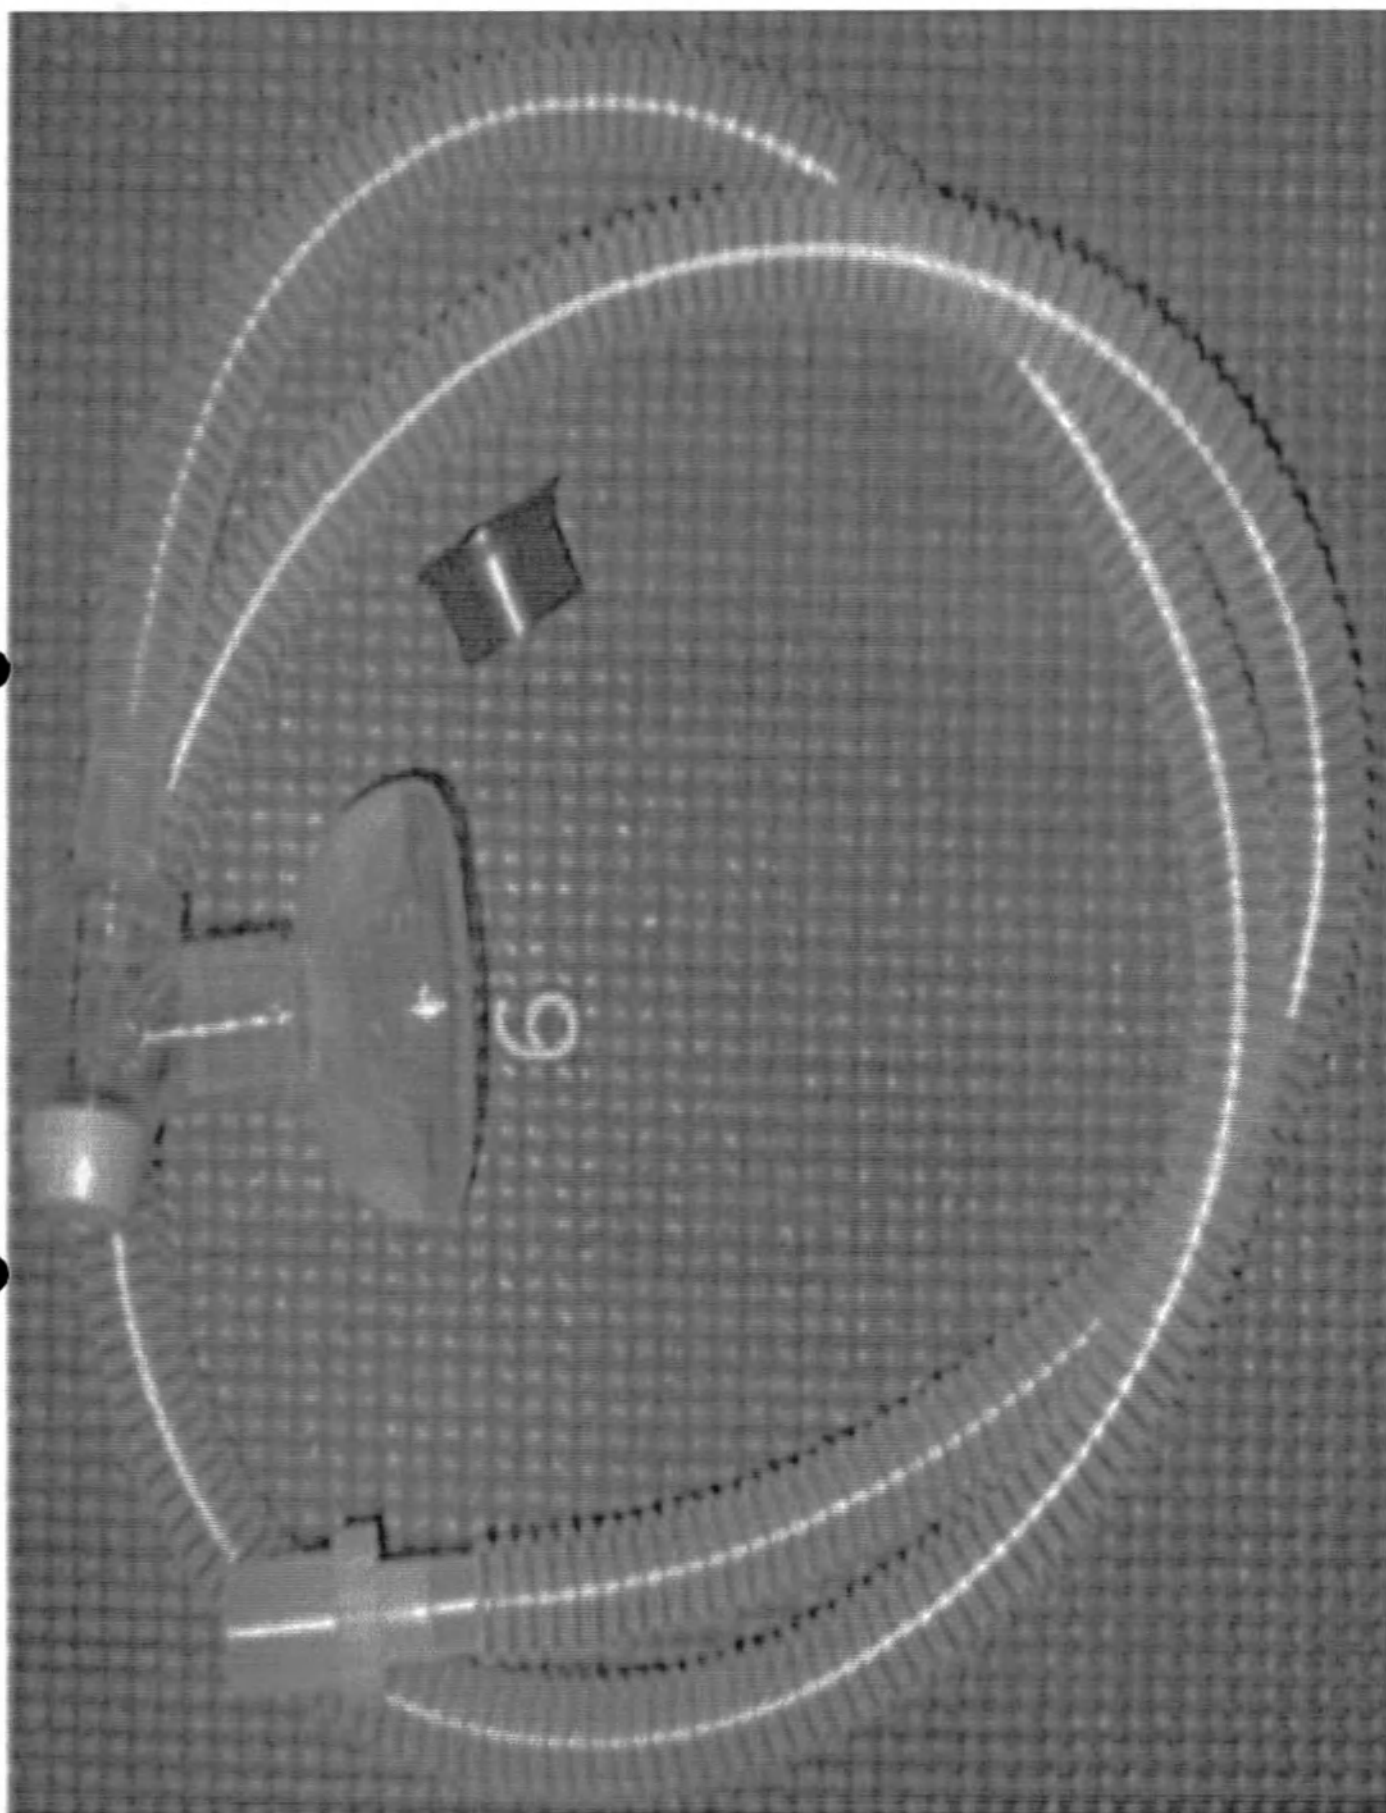

12. Блок контроля подачи кислорода (при необходимости).



13. Лампа фототерапии со световодом, СЕ или ІЕС (при необходимости).

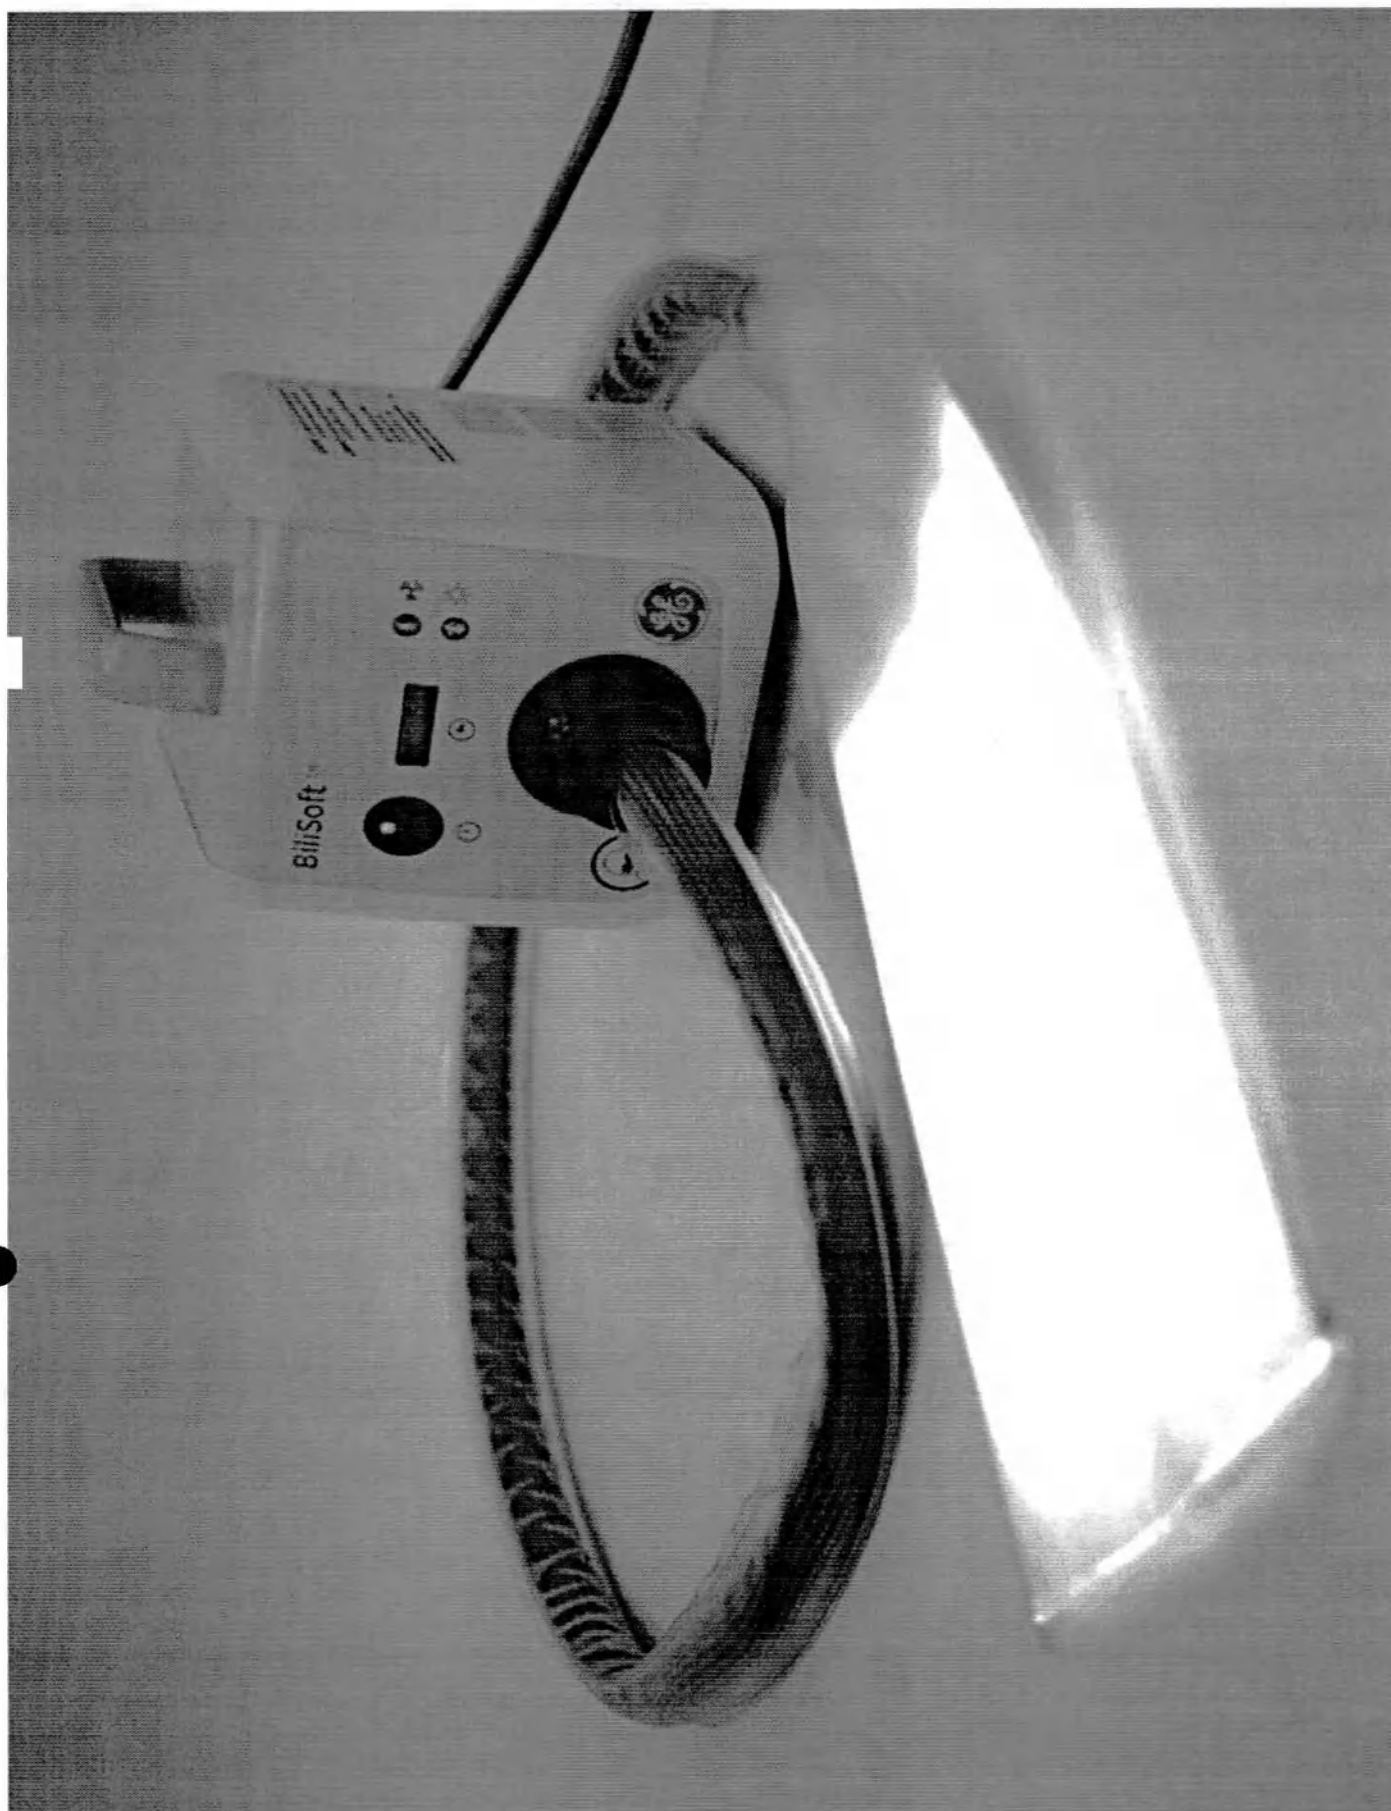


14. Датчики кислорода, не более 30 шт. (при необходимости).




15. Датчики для измерения температуры для новорожденных, одноразовые, 10 и/или 50 шт/уп не более 50 шт. (при необходимости).




16. Датчики для измерения температуры для новорожденных, многоразовые, не более 100 шт. (при необходимости).

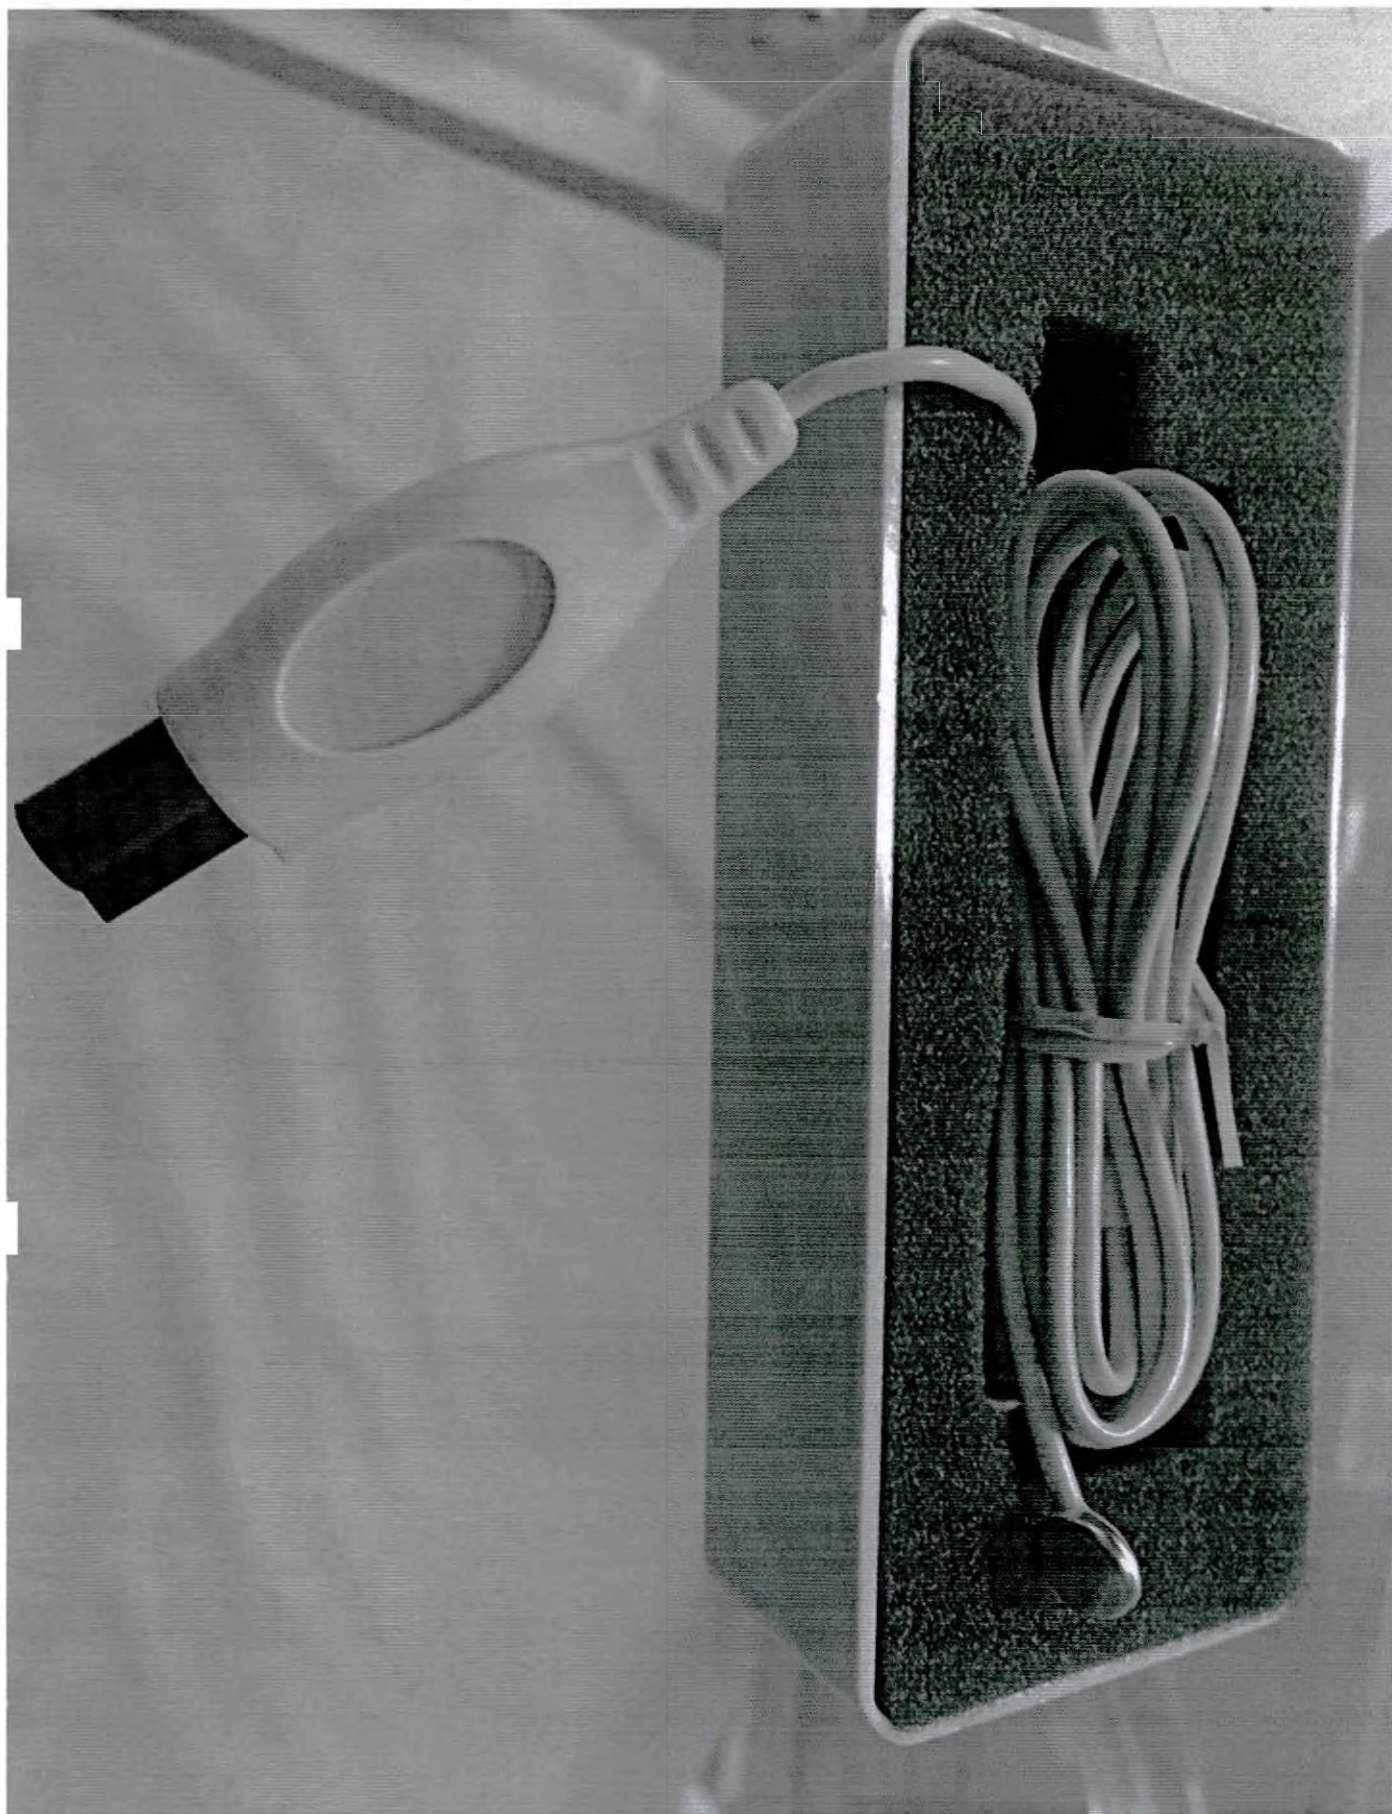

17. Пластырь теплоотражающий, одноразовый, для крепления температурного датчика на коже (не более 500 шт.)
(при необходимости).

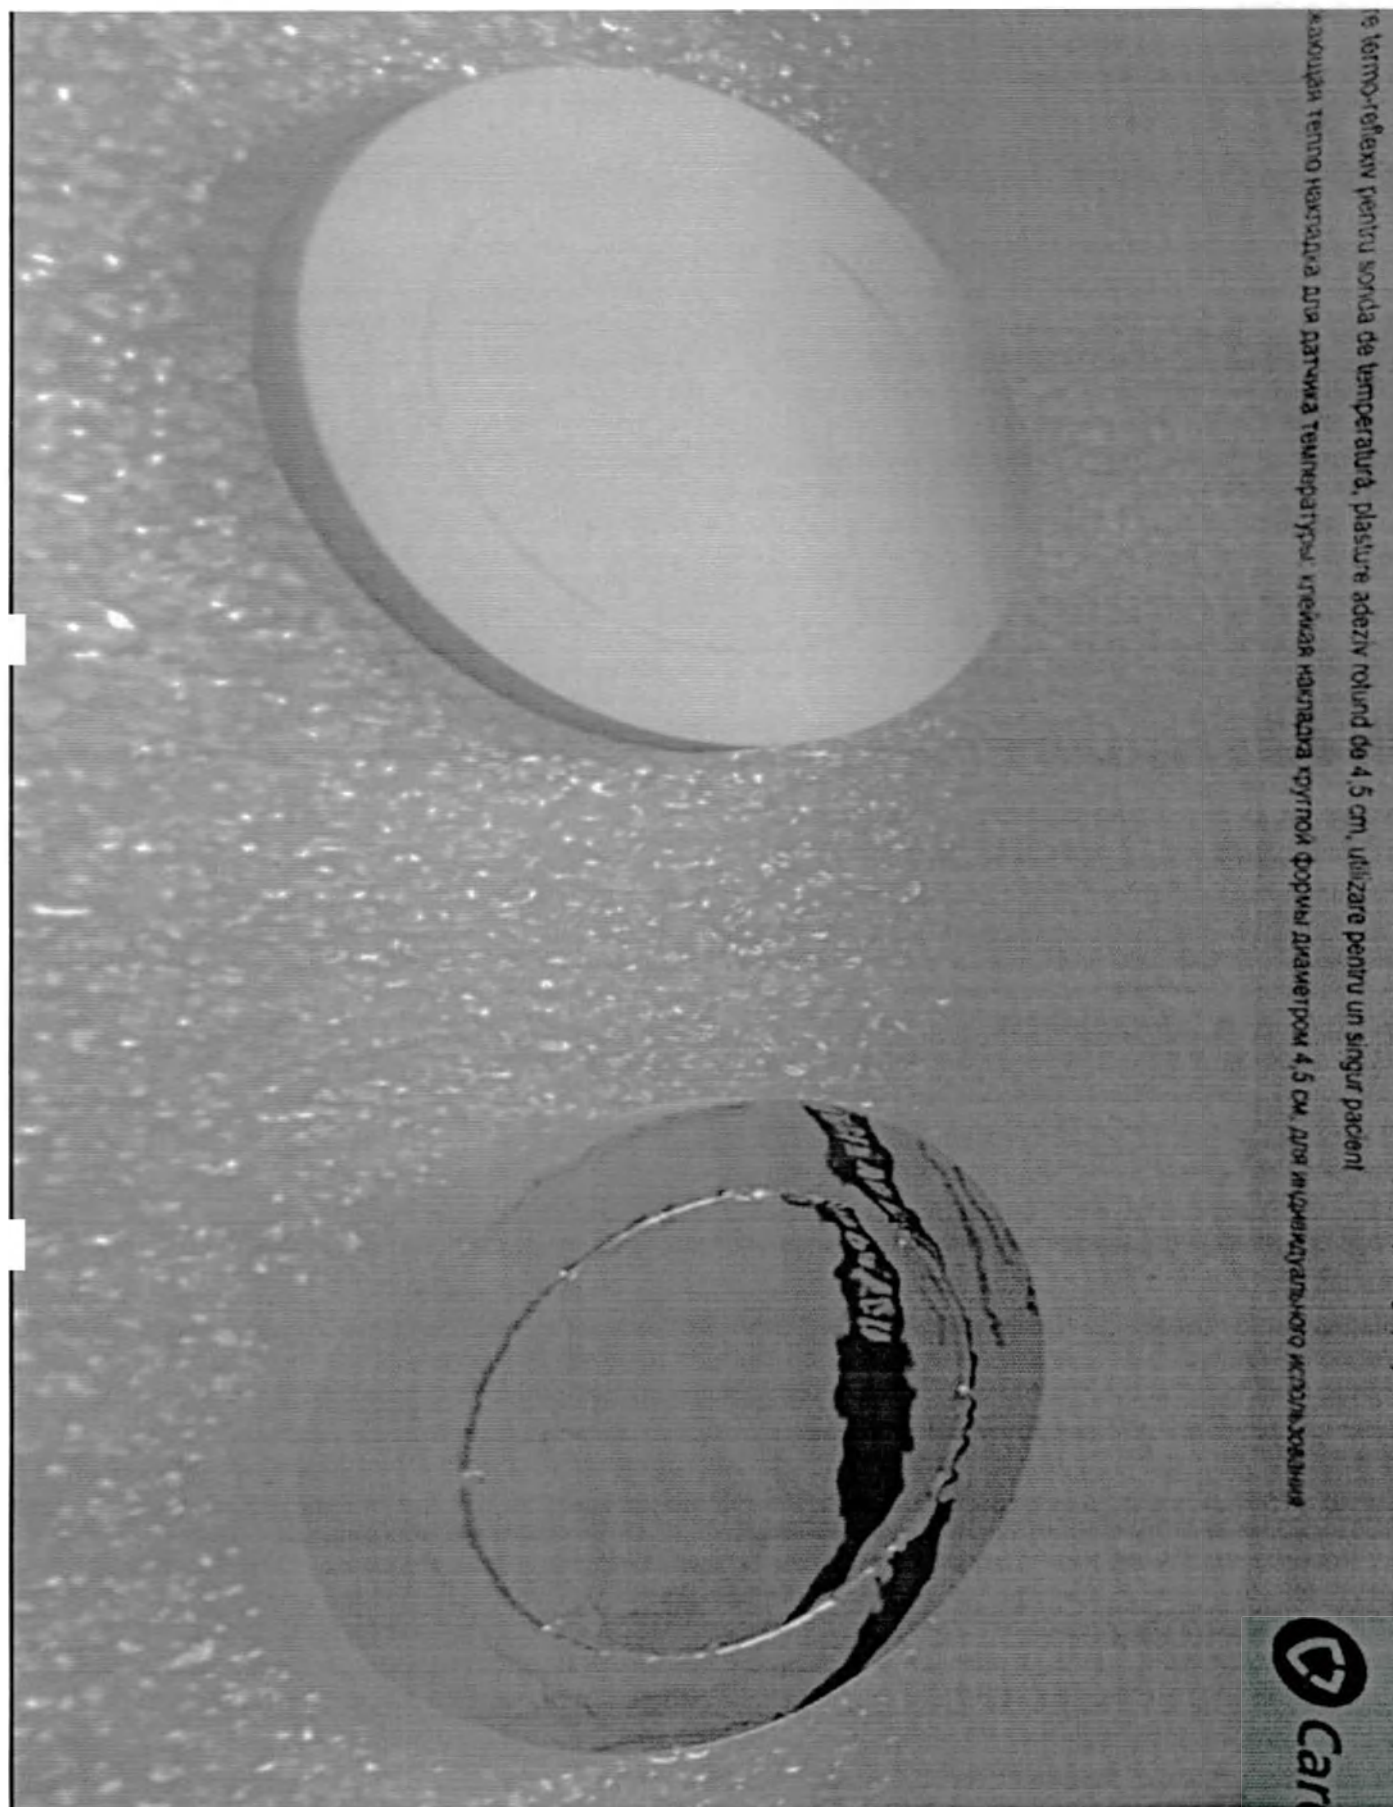


18. Камеры увлажнения для воды не более 5 шт (при необходимости).

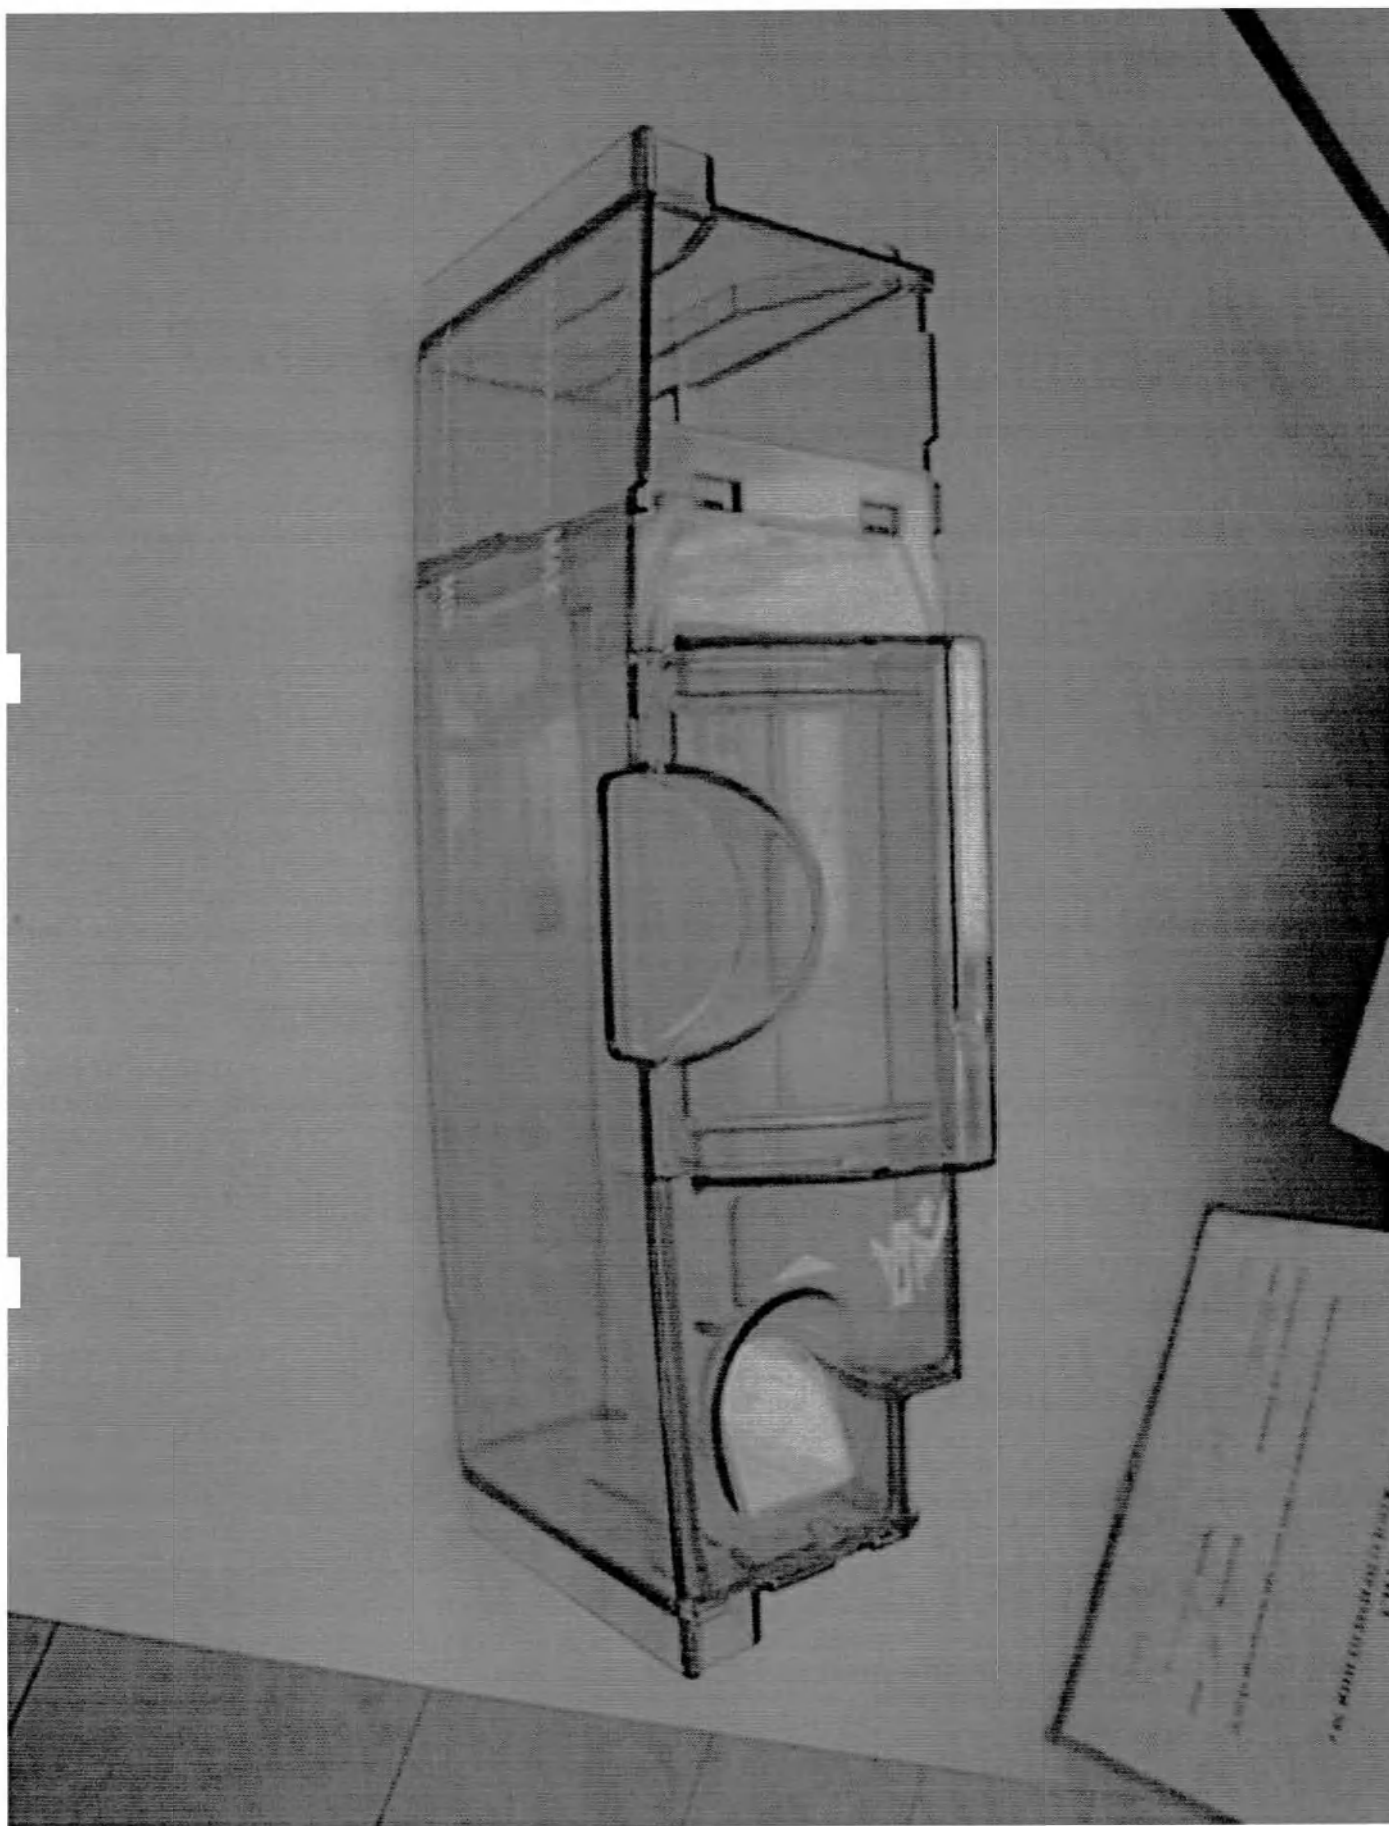


19. Флоуметры (для регулировки подачи кислорода), не более 5 шт (при необходимости).





20. Т-образный контур одноразовый, 20 шт/уп., (не более 50 шт.) (при необходимости).

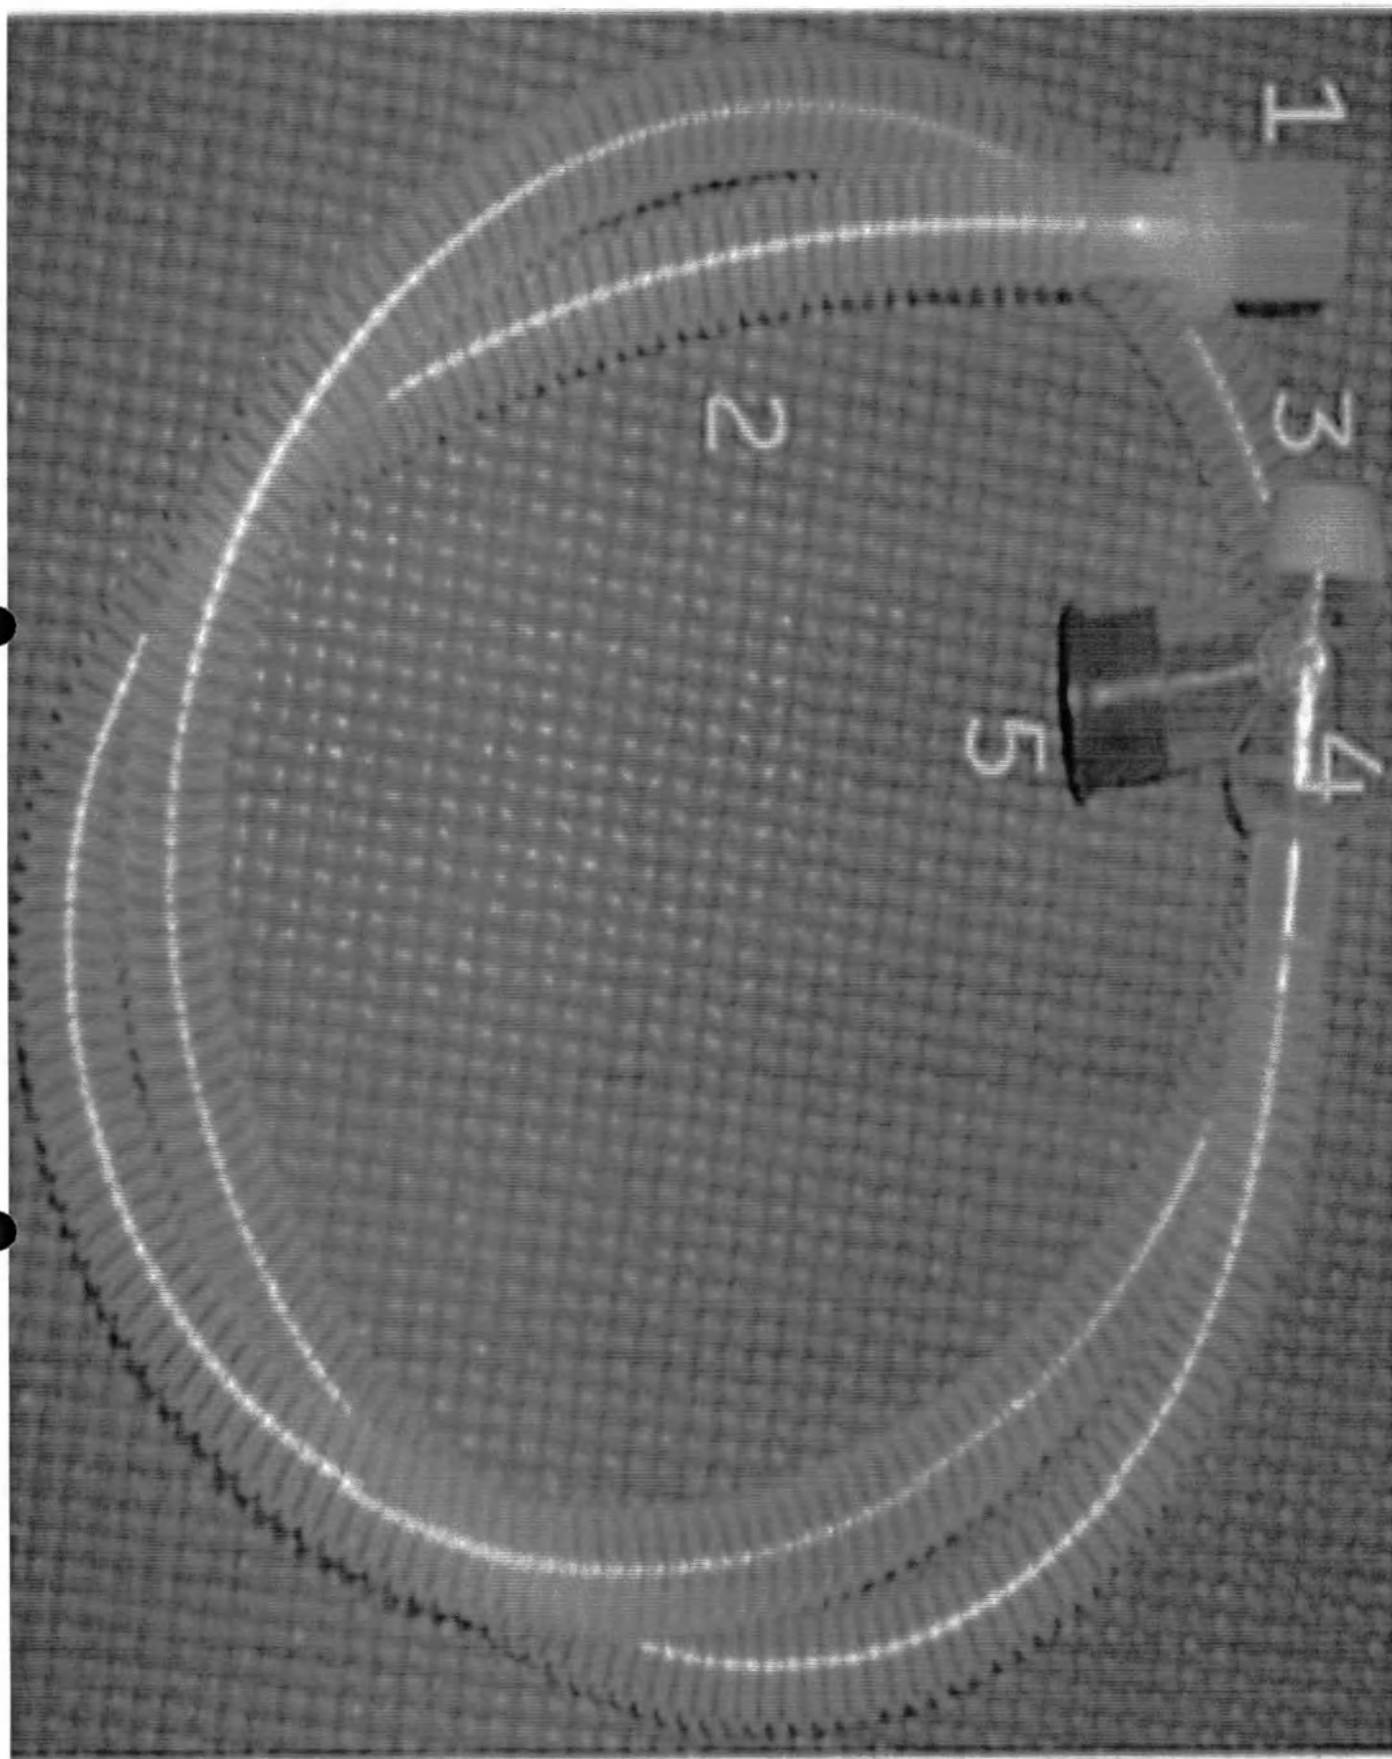

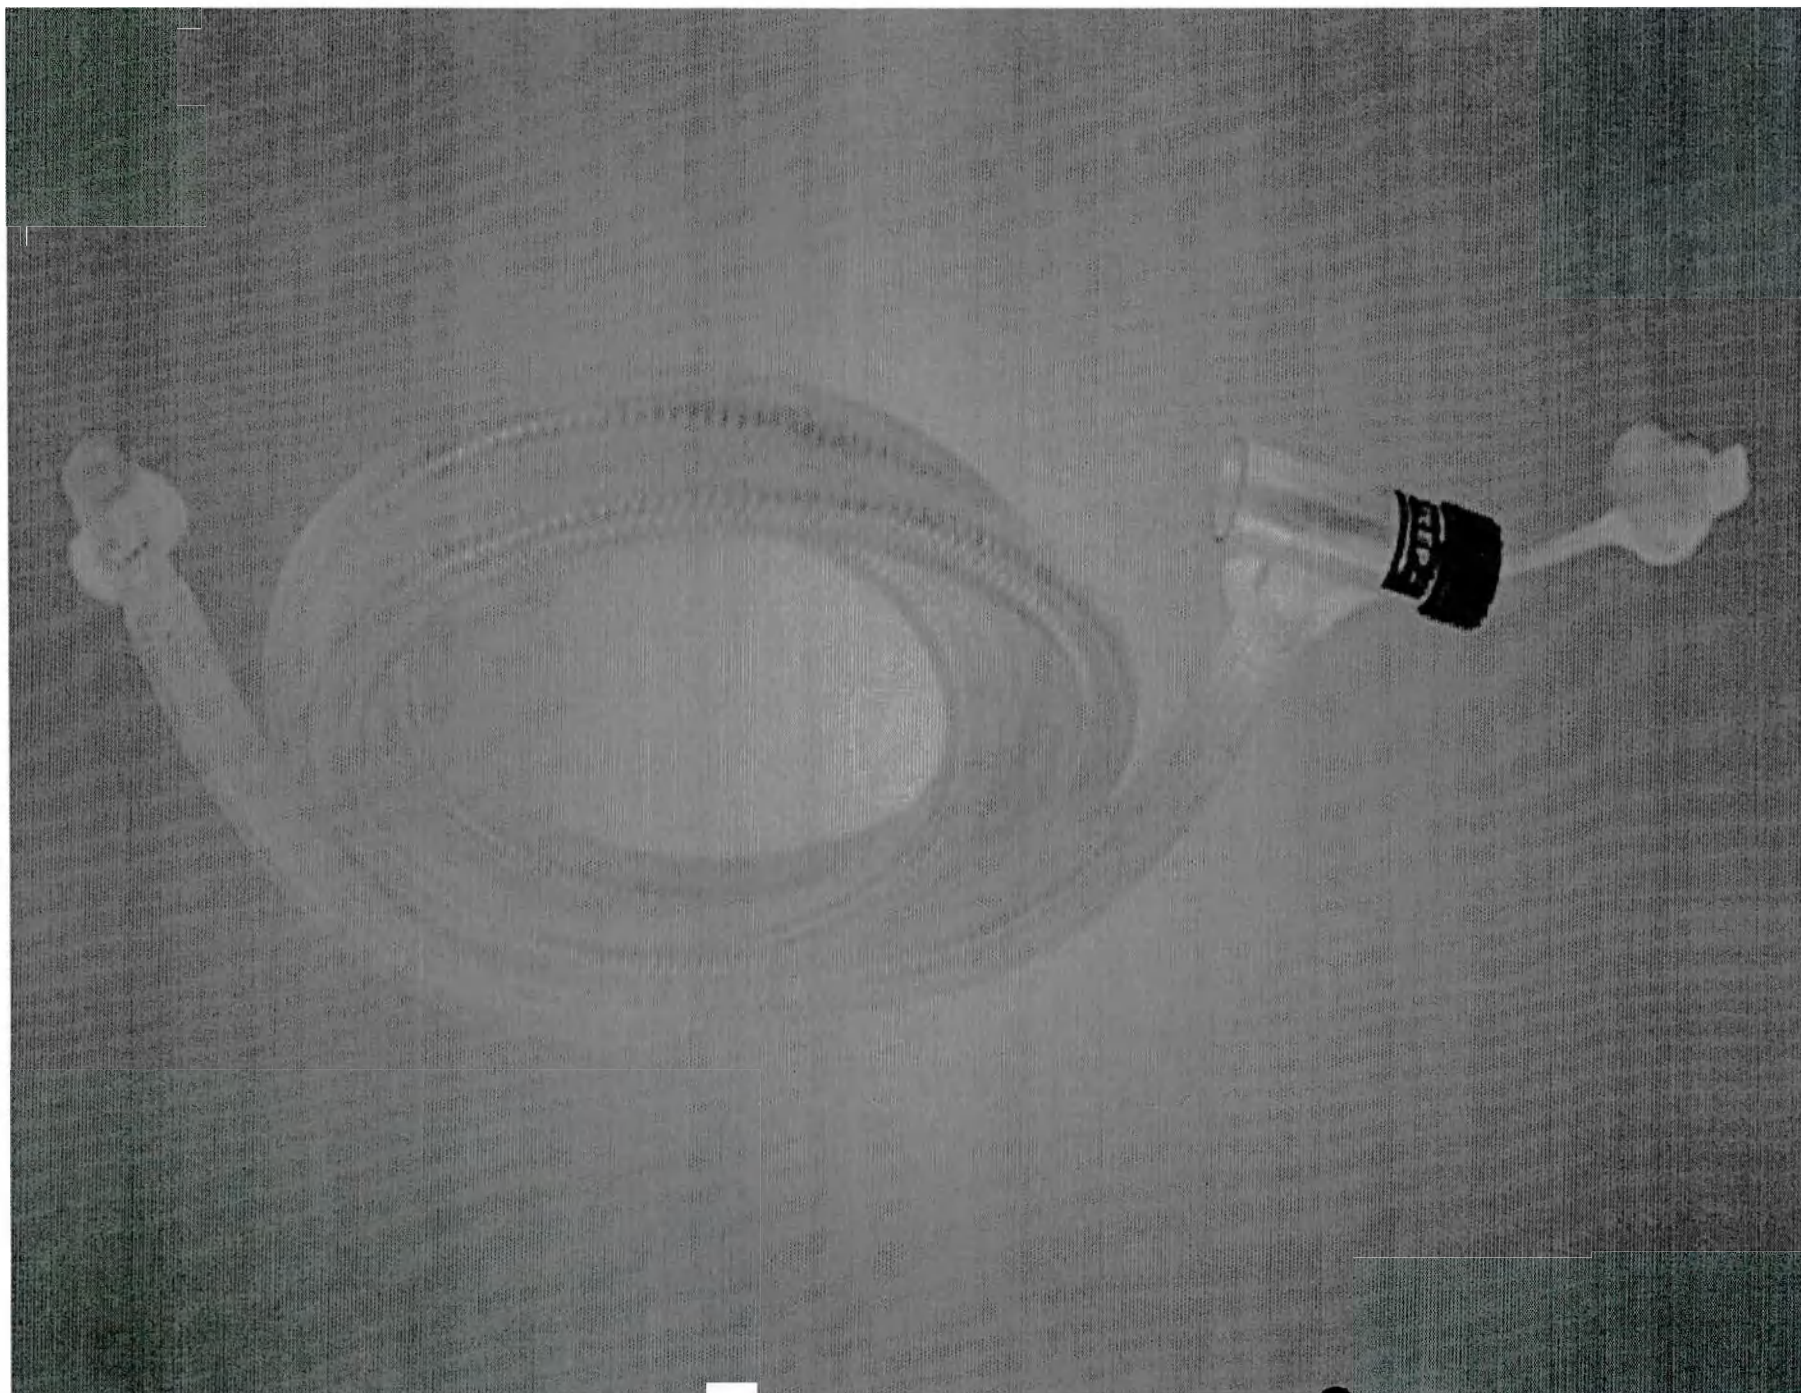


21. Т-образный контур, одноразовый, с маской, неонатальный, 20 шт/уп, (не более 50 шт.) (при необходимости).

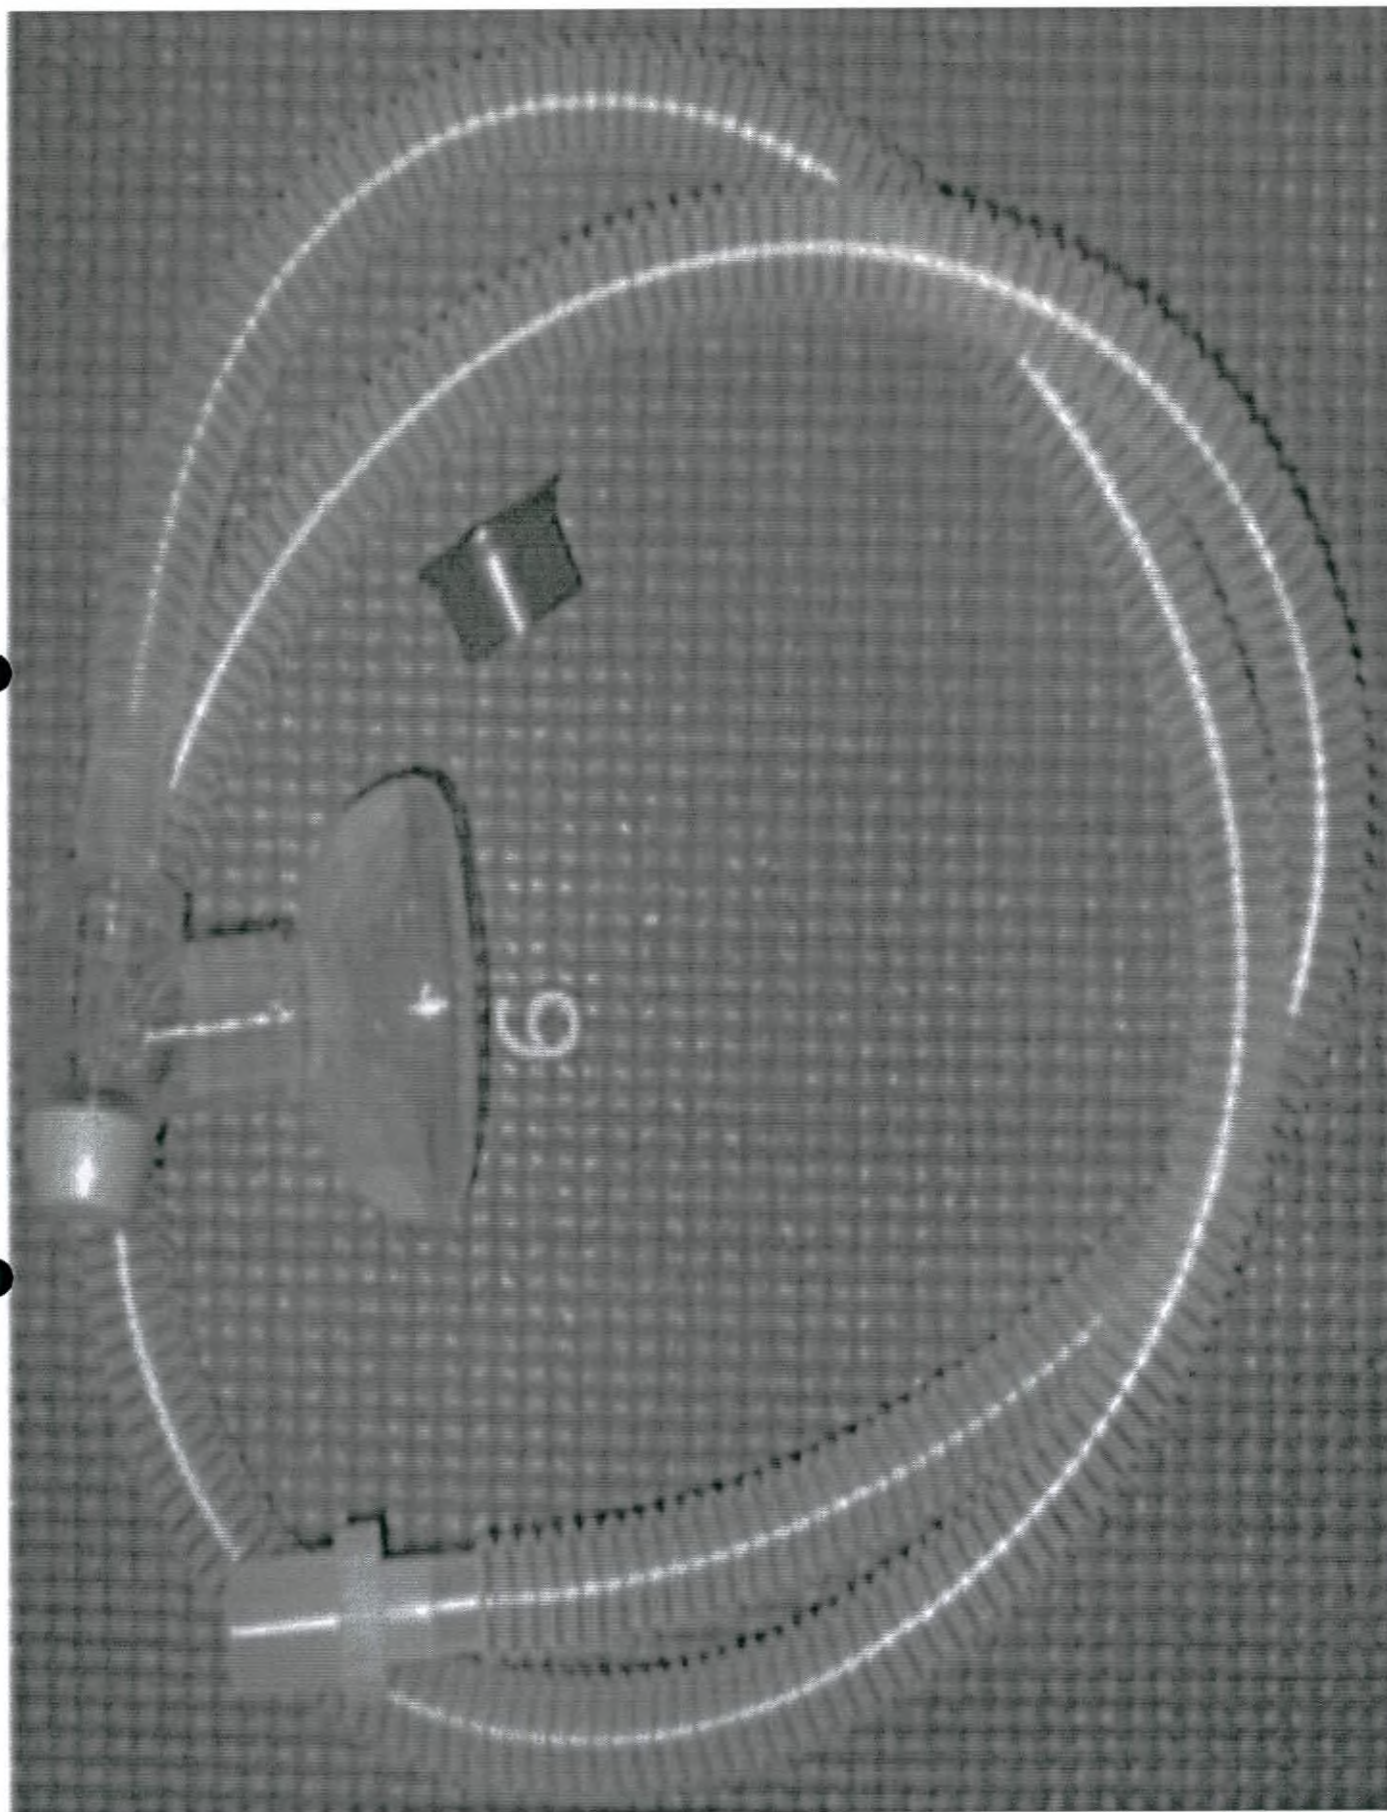


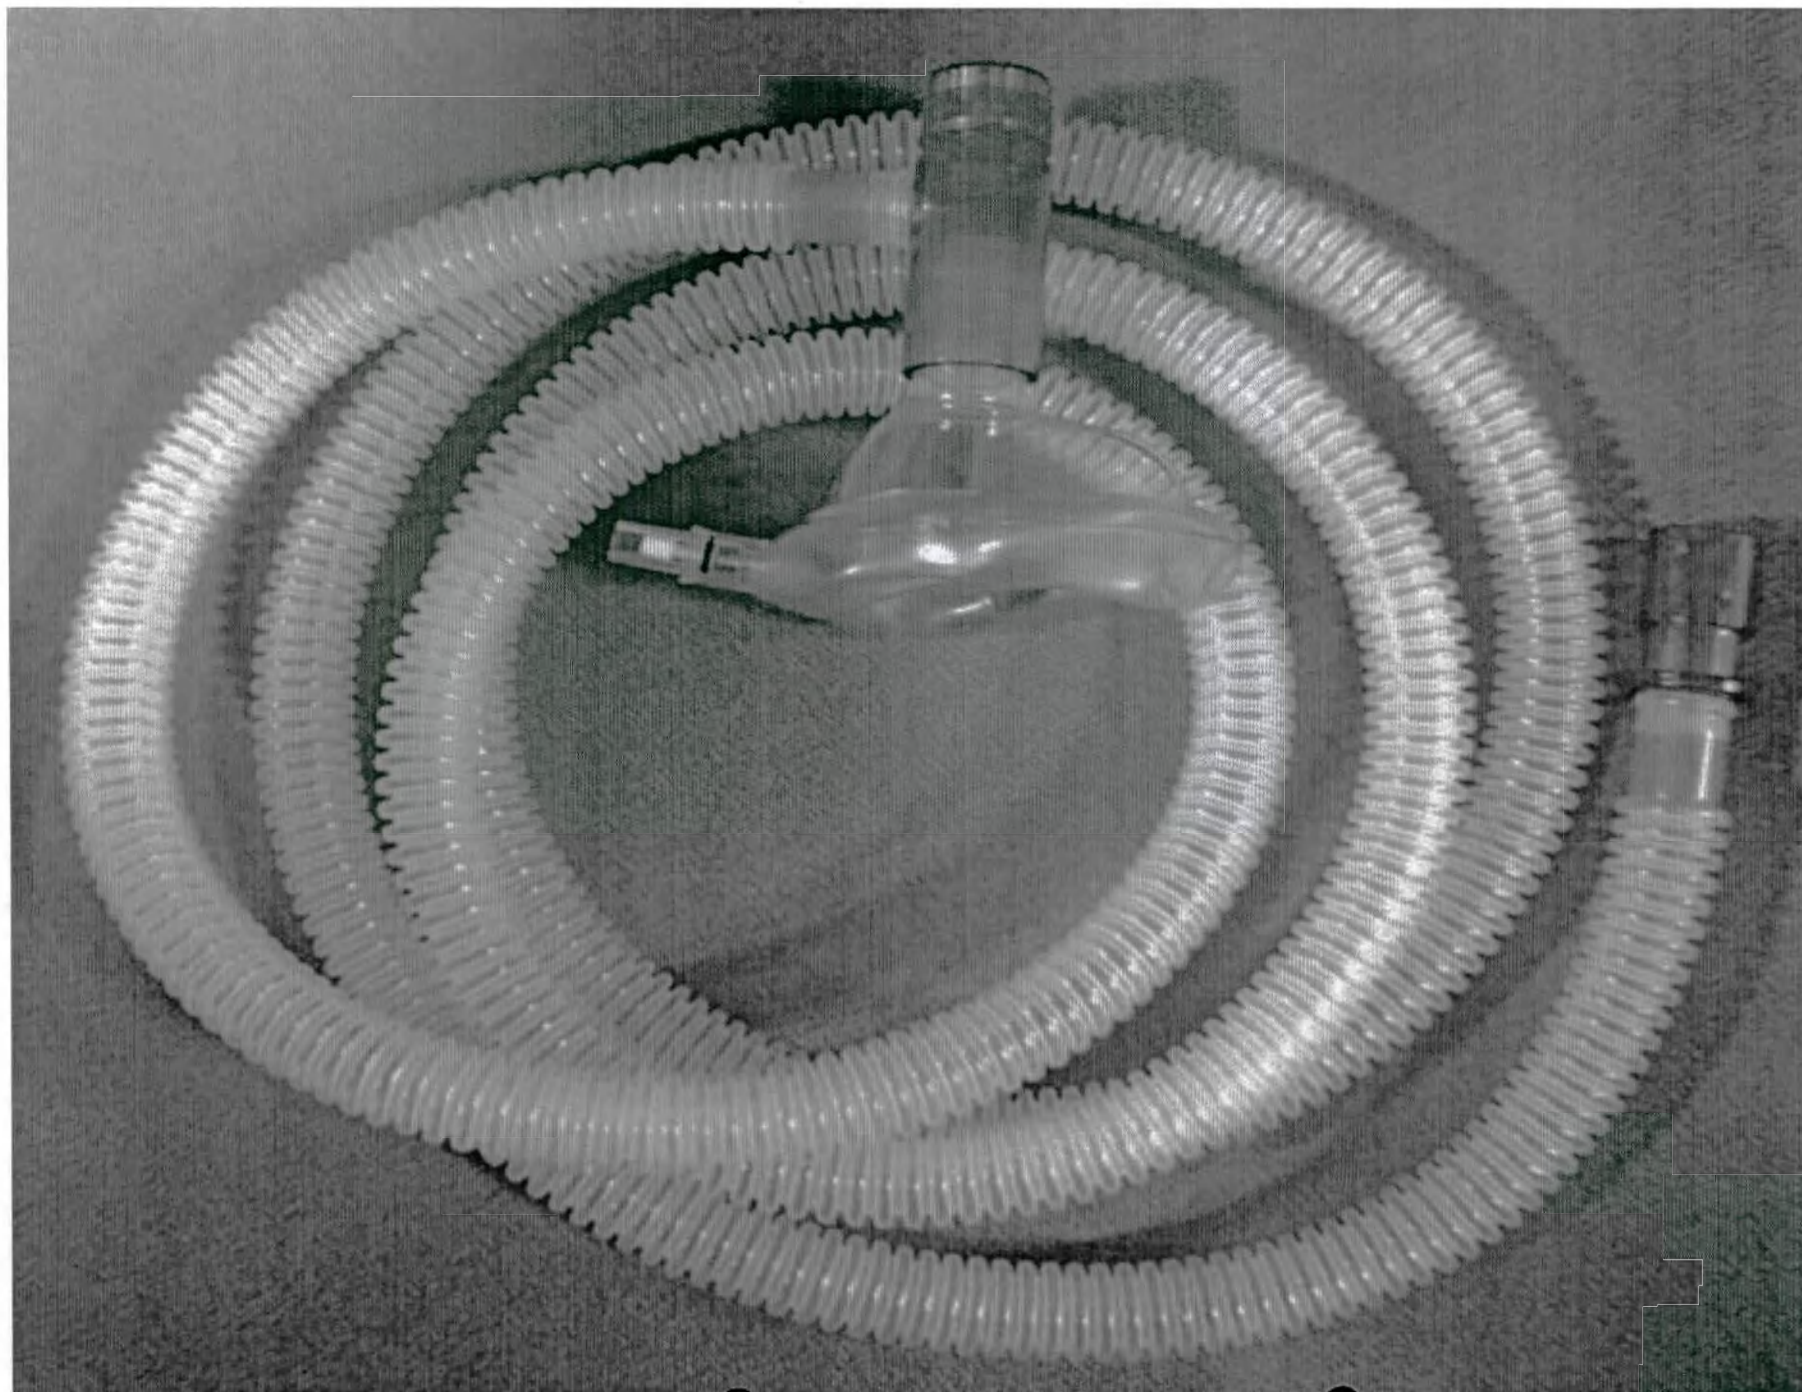


22. Т-образный контур одноразовый, с маской, для младенцев, 20 шт/уп, (не более 50 шт.) (при необходимости).

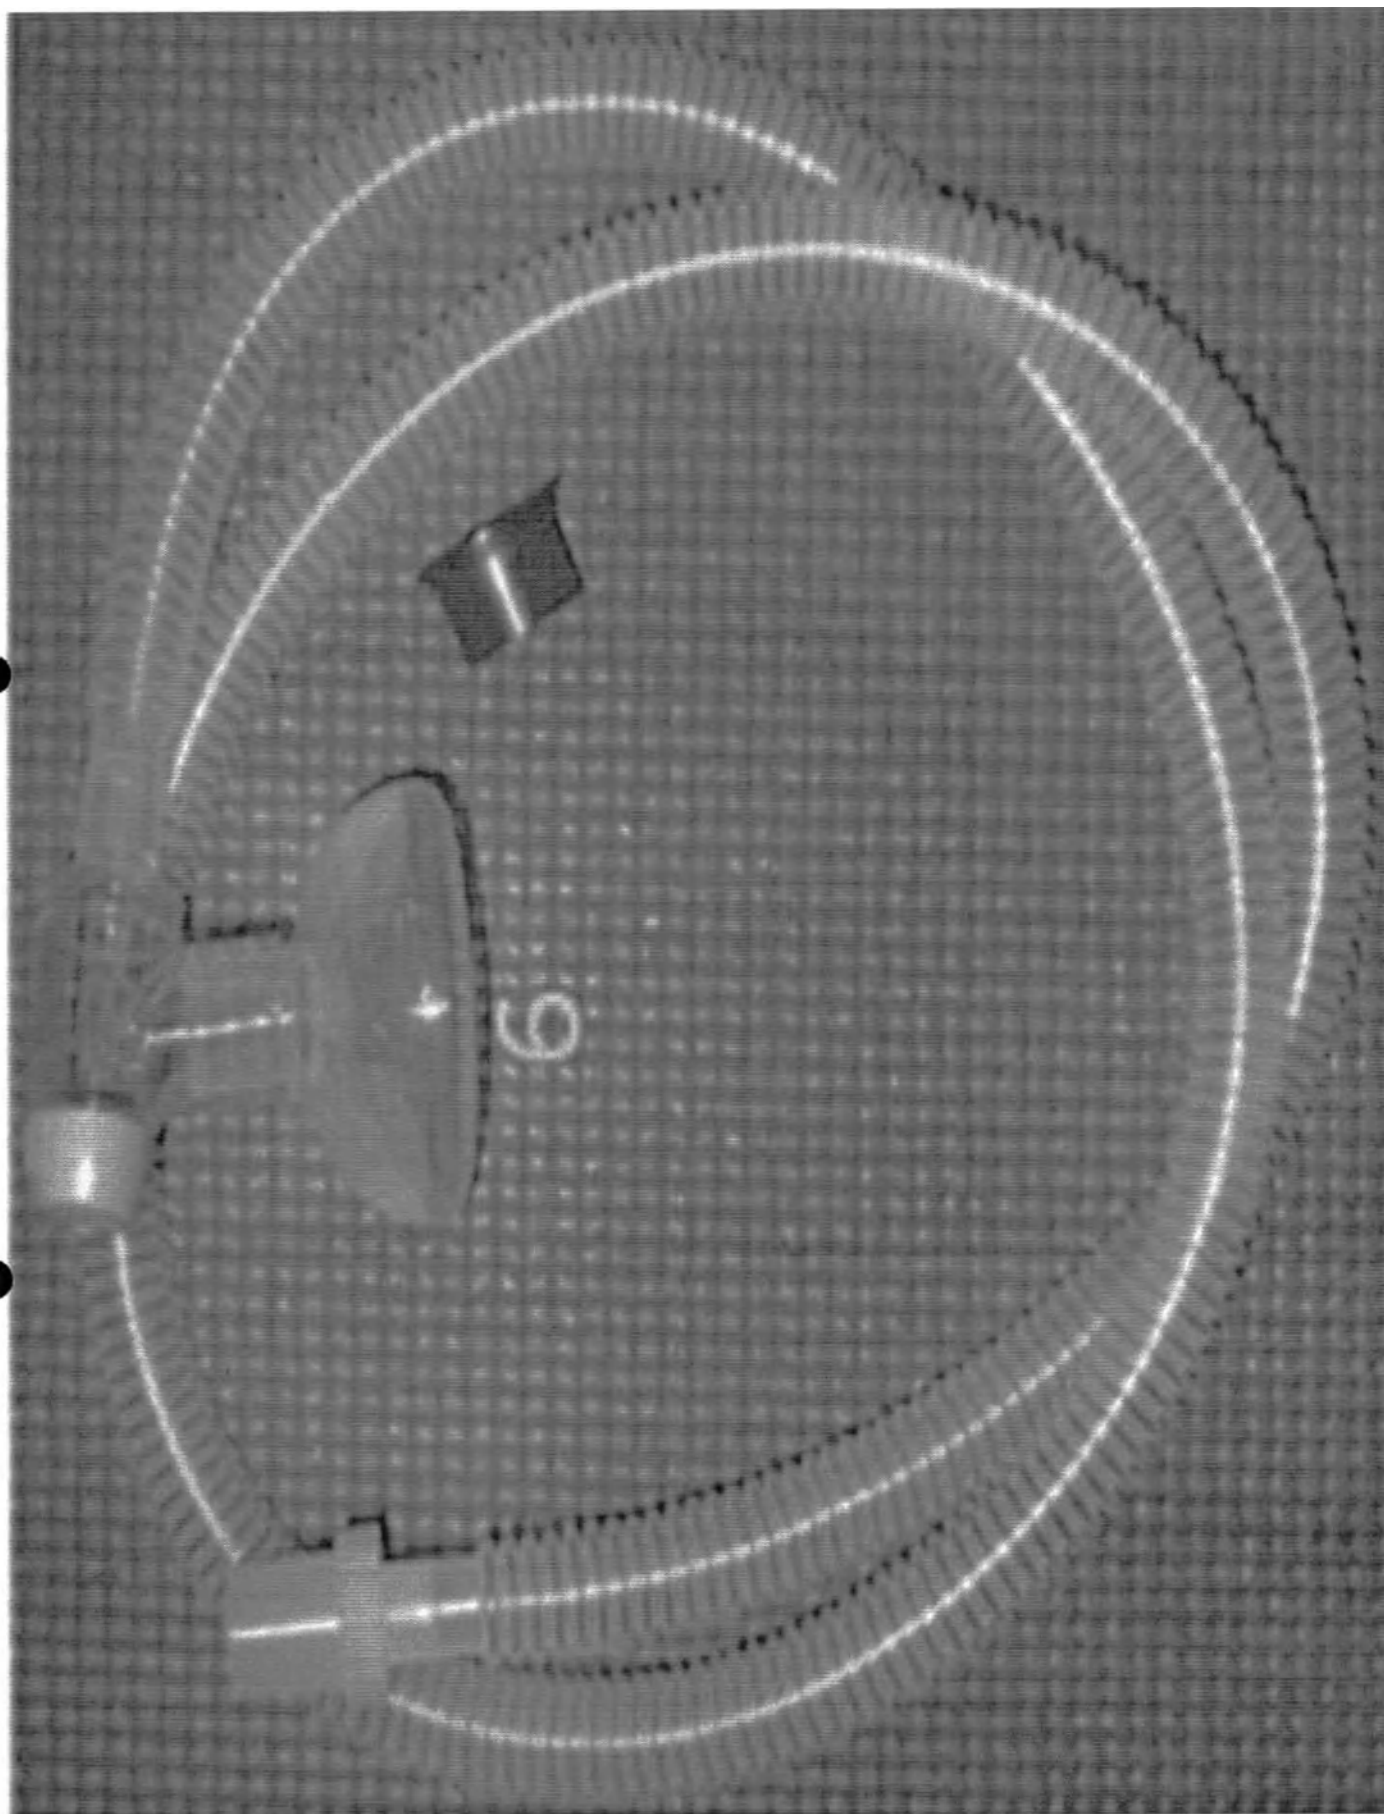


23. Дверцы инкубатора, не более 10 шт.

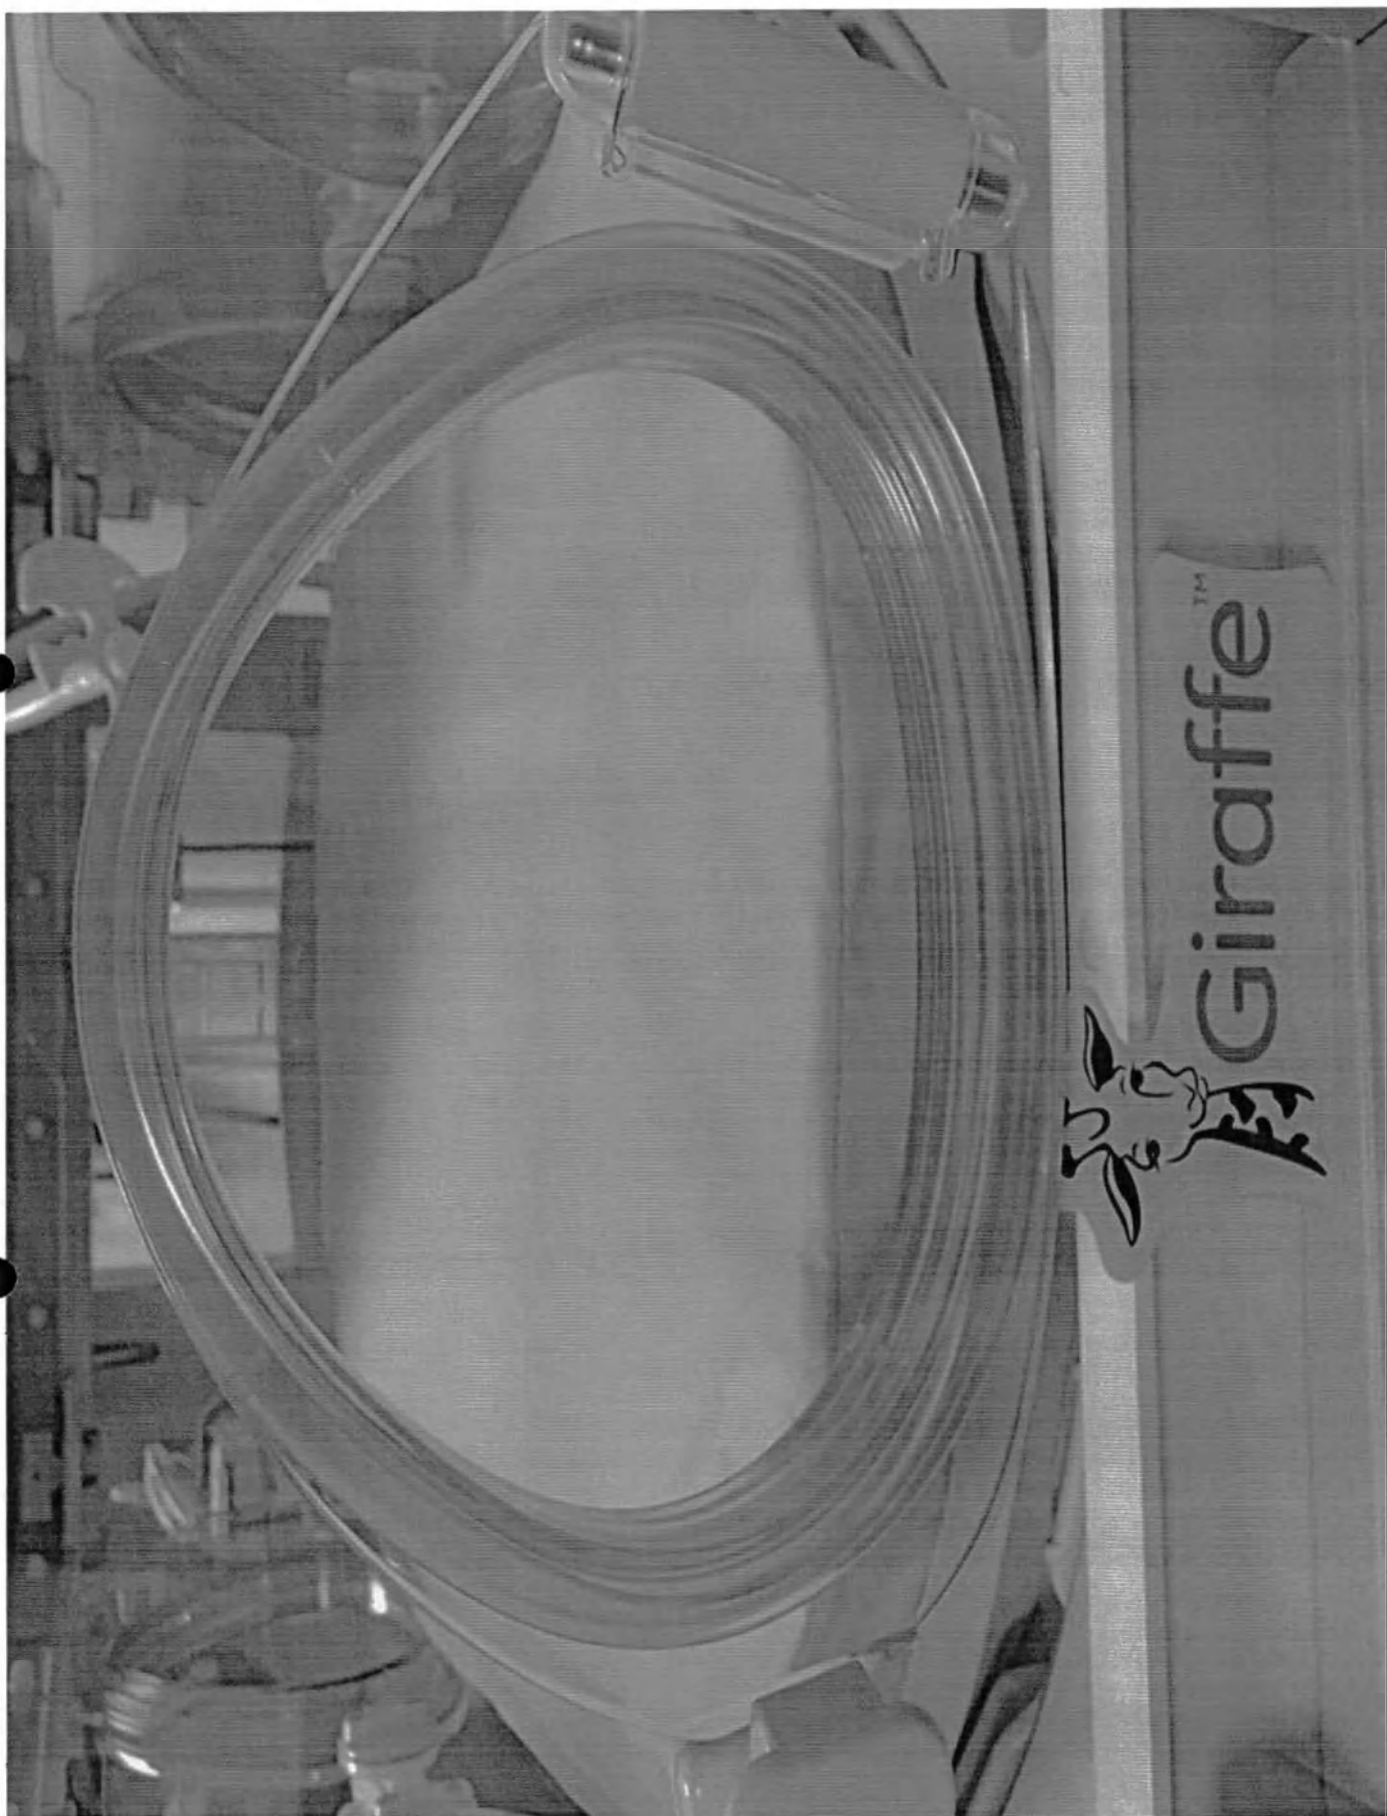

24. Направляющие для приборов, не более 5 шт.

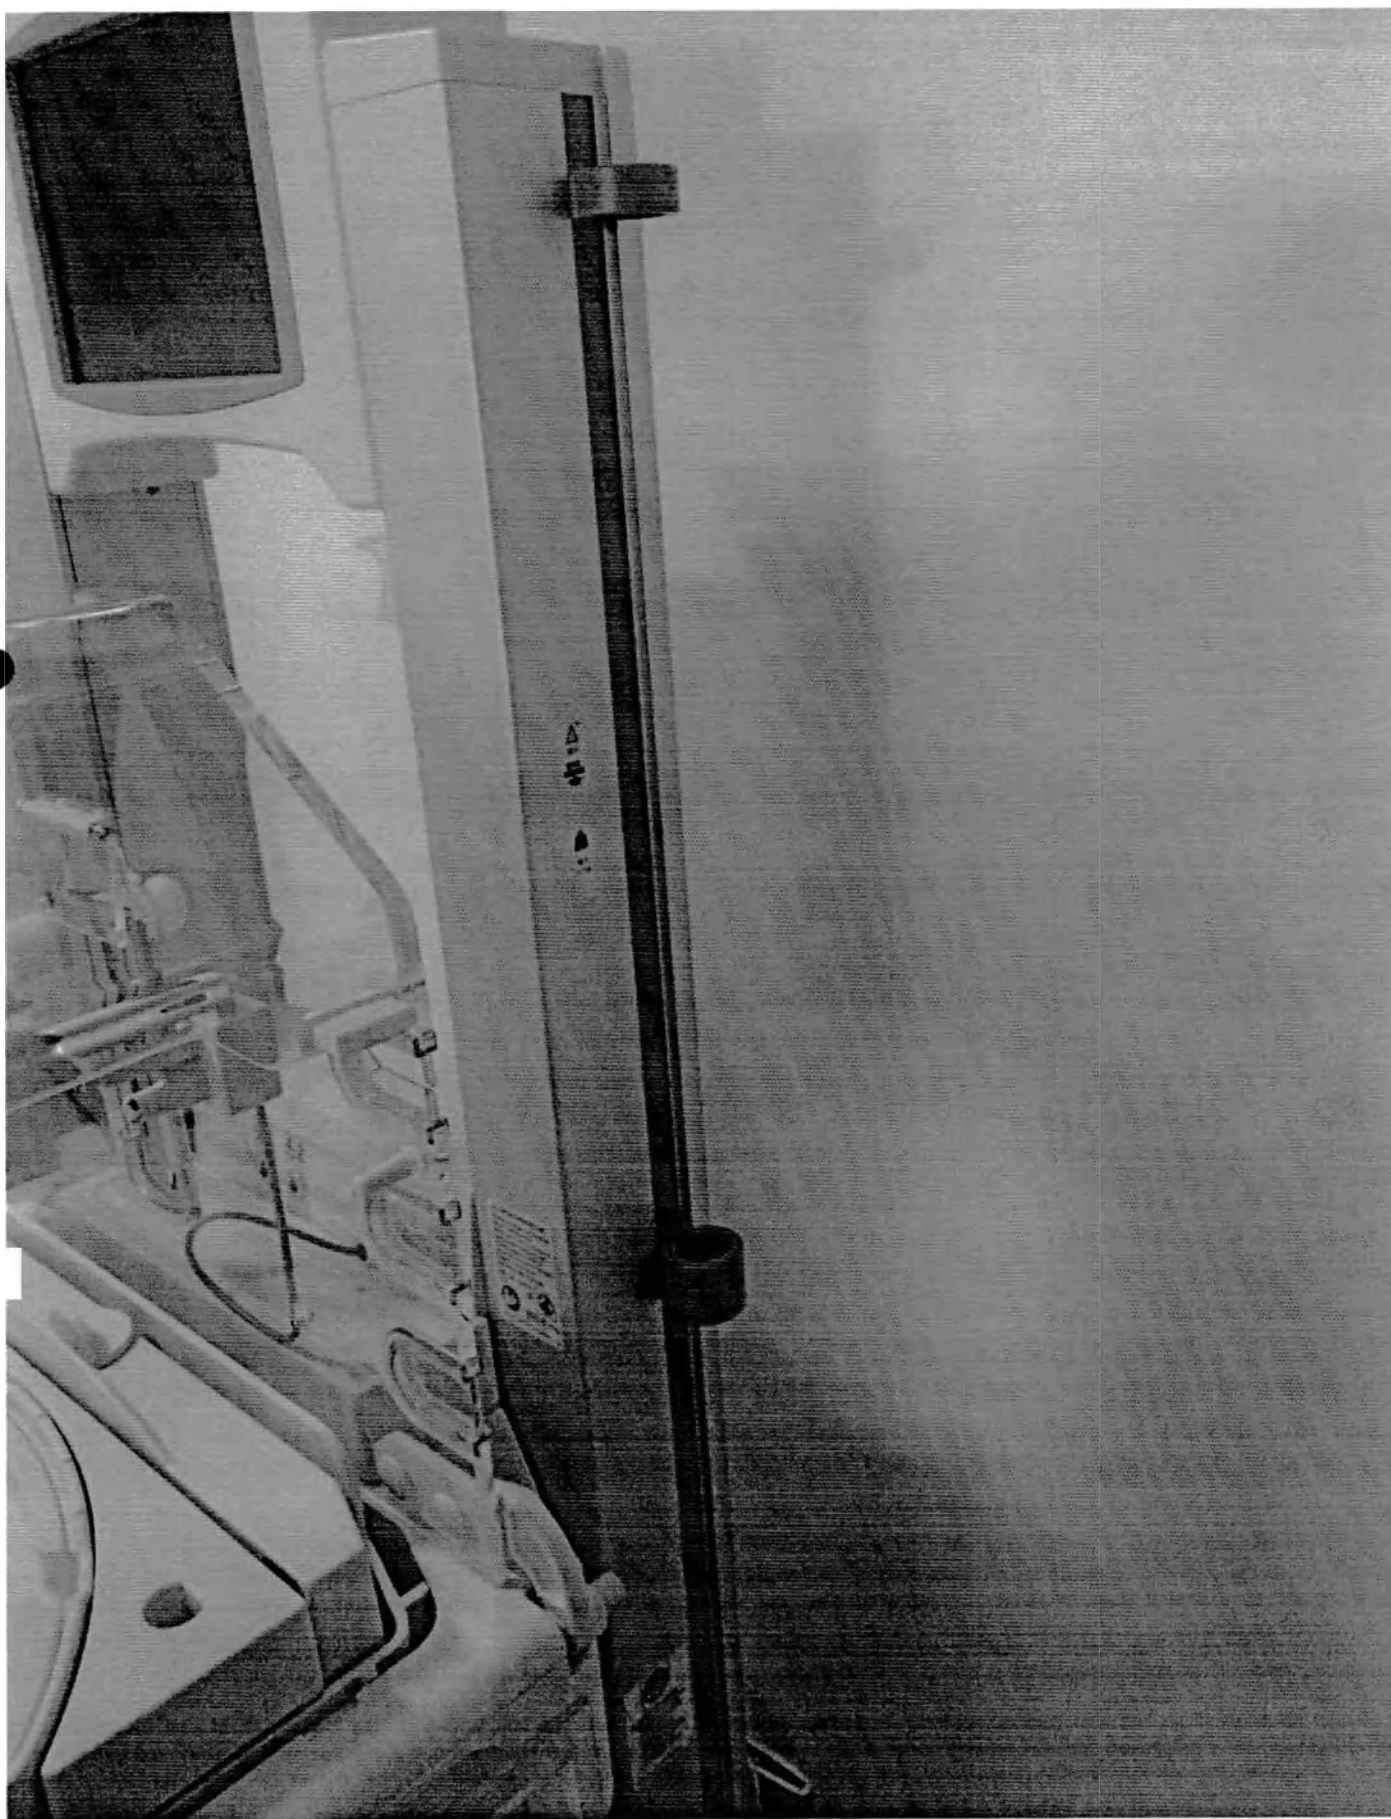


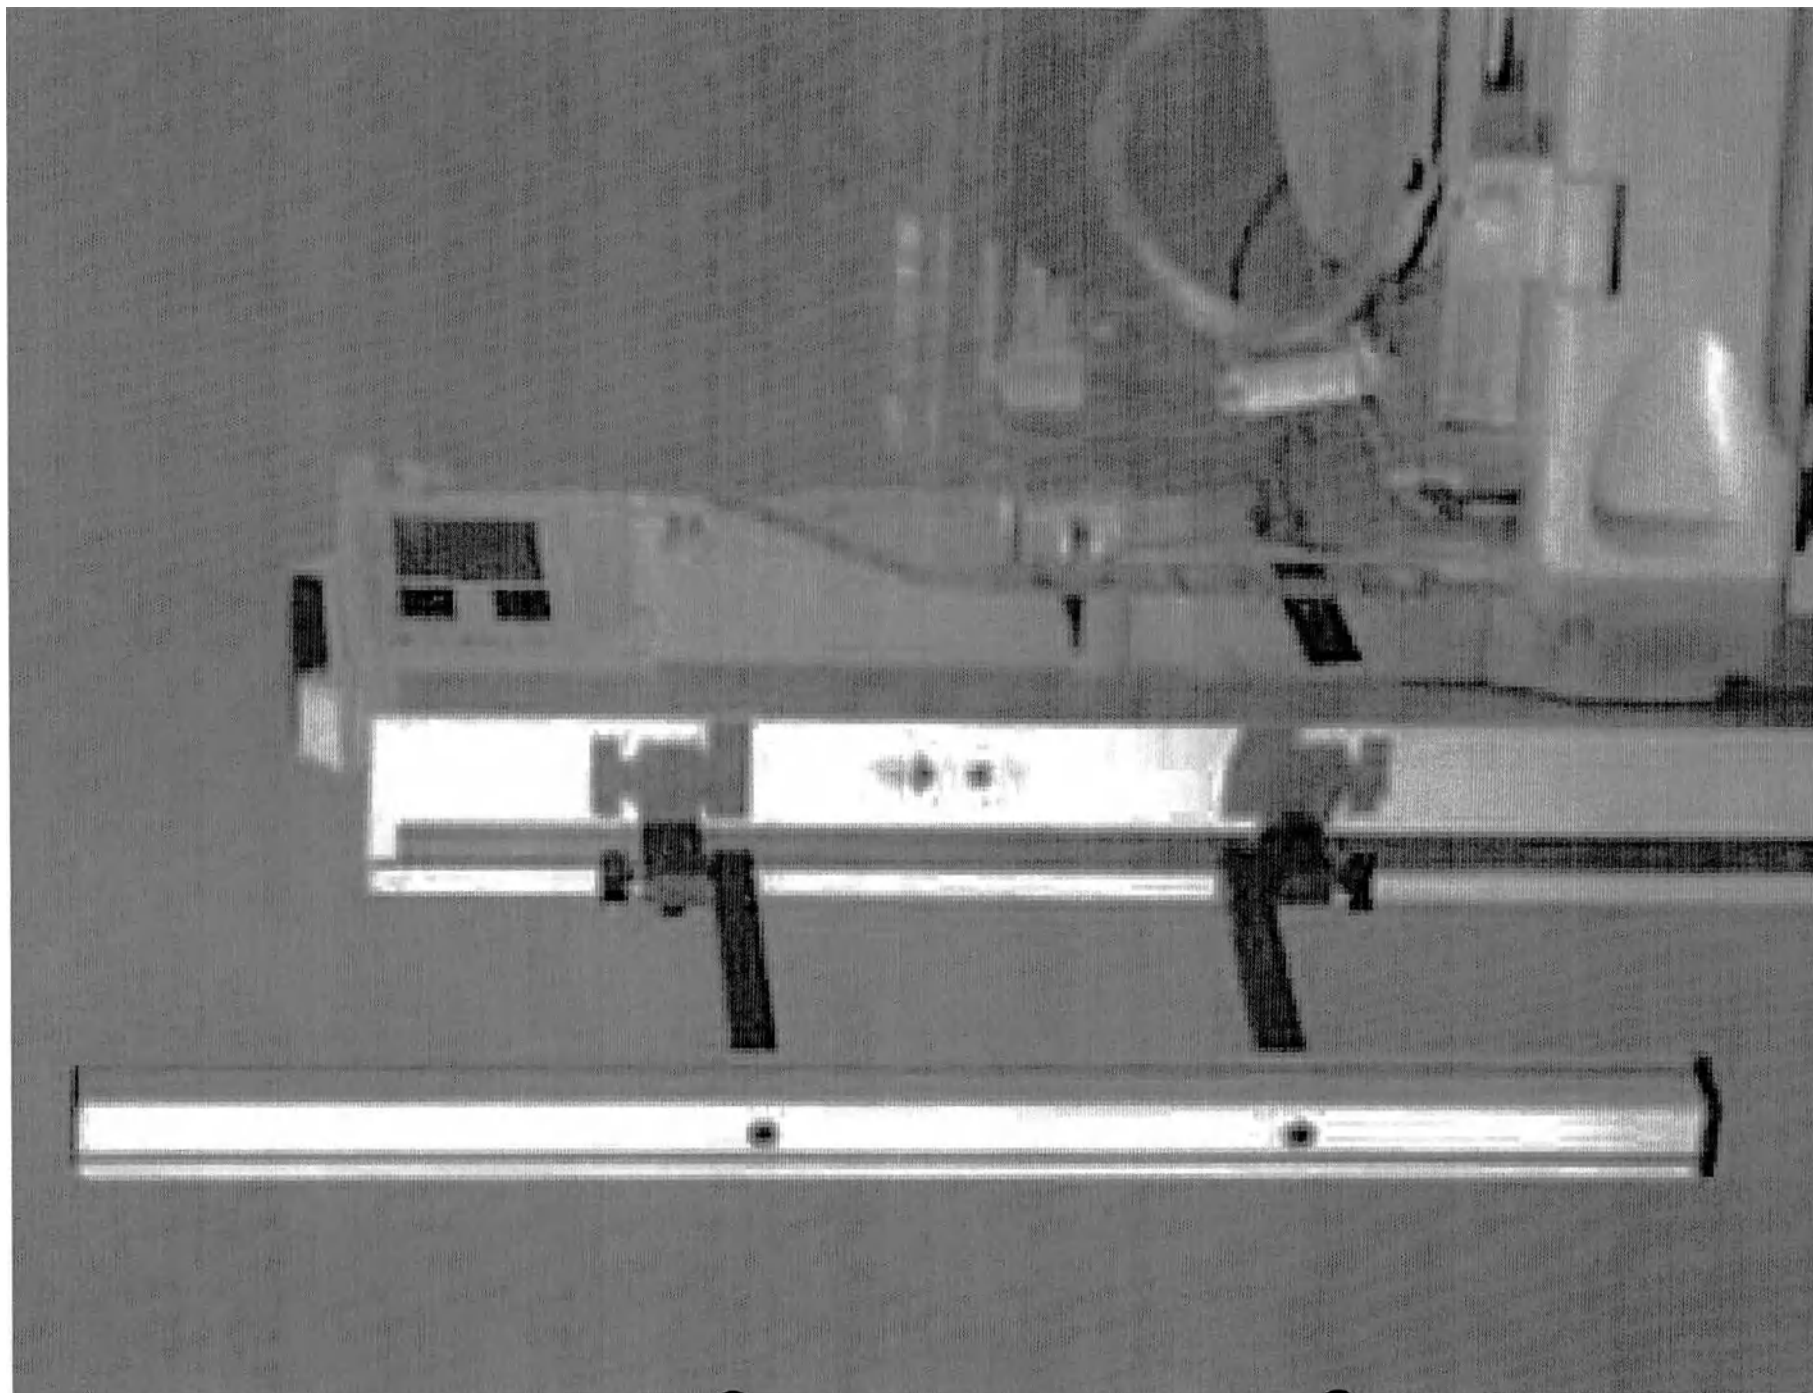


25. Емкости для аспираторов, не более 100 шт.



26. Вентилятор для циркуляции воздуха.

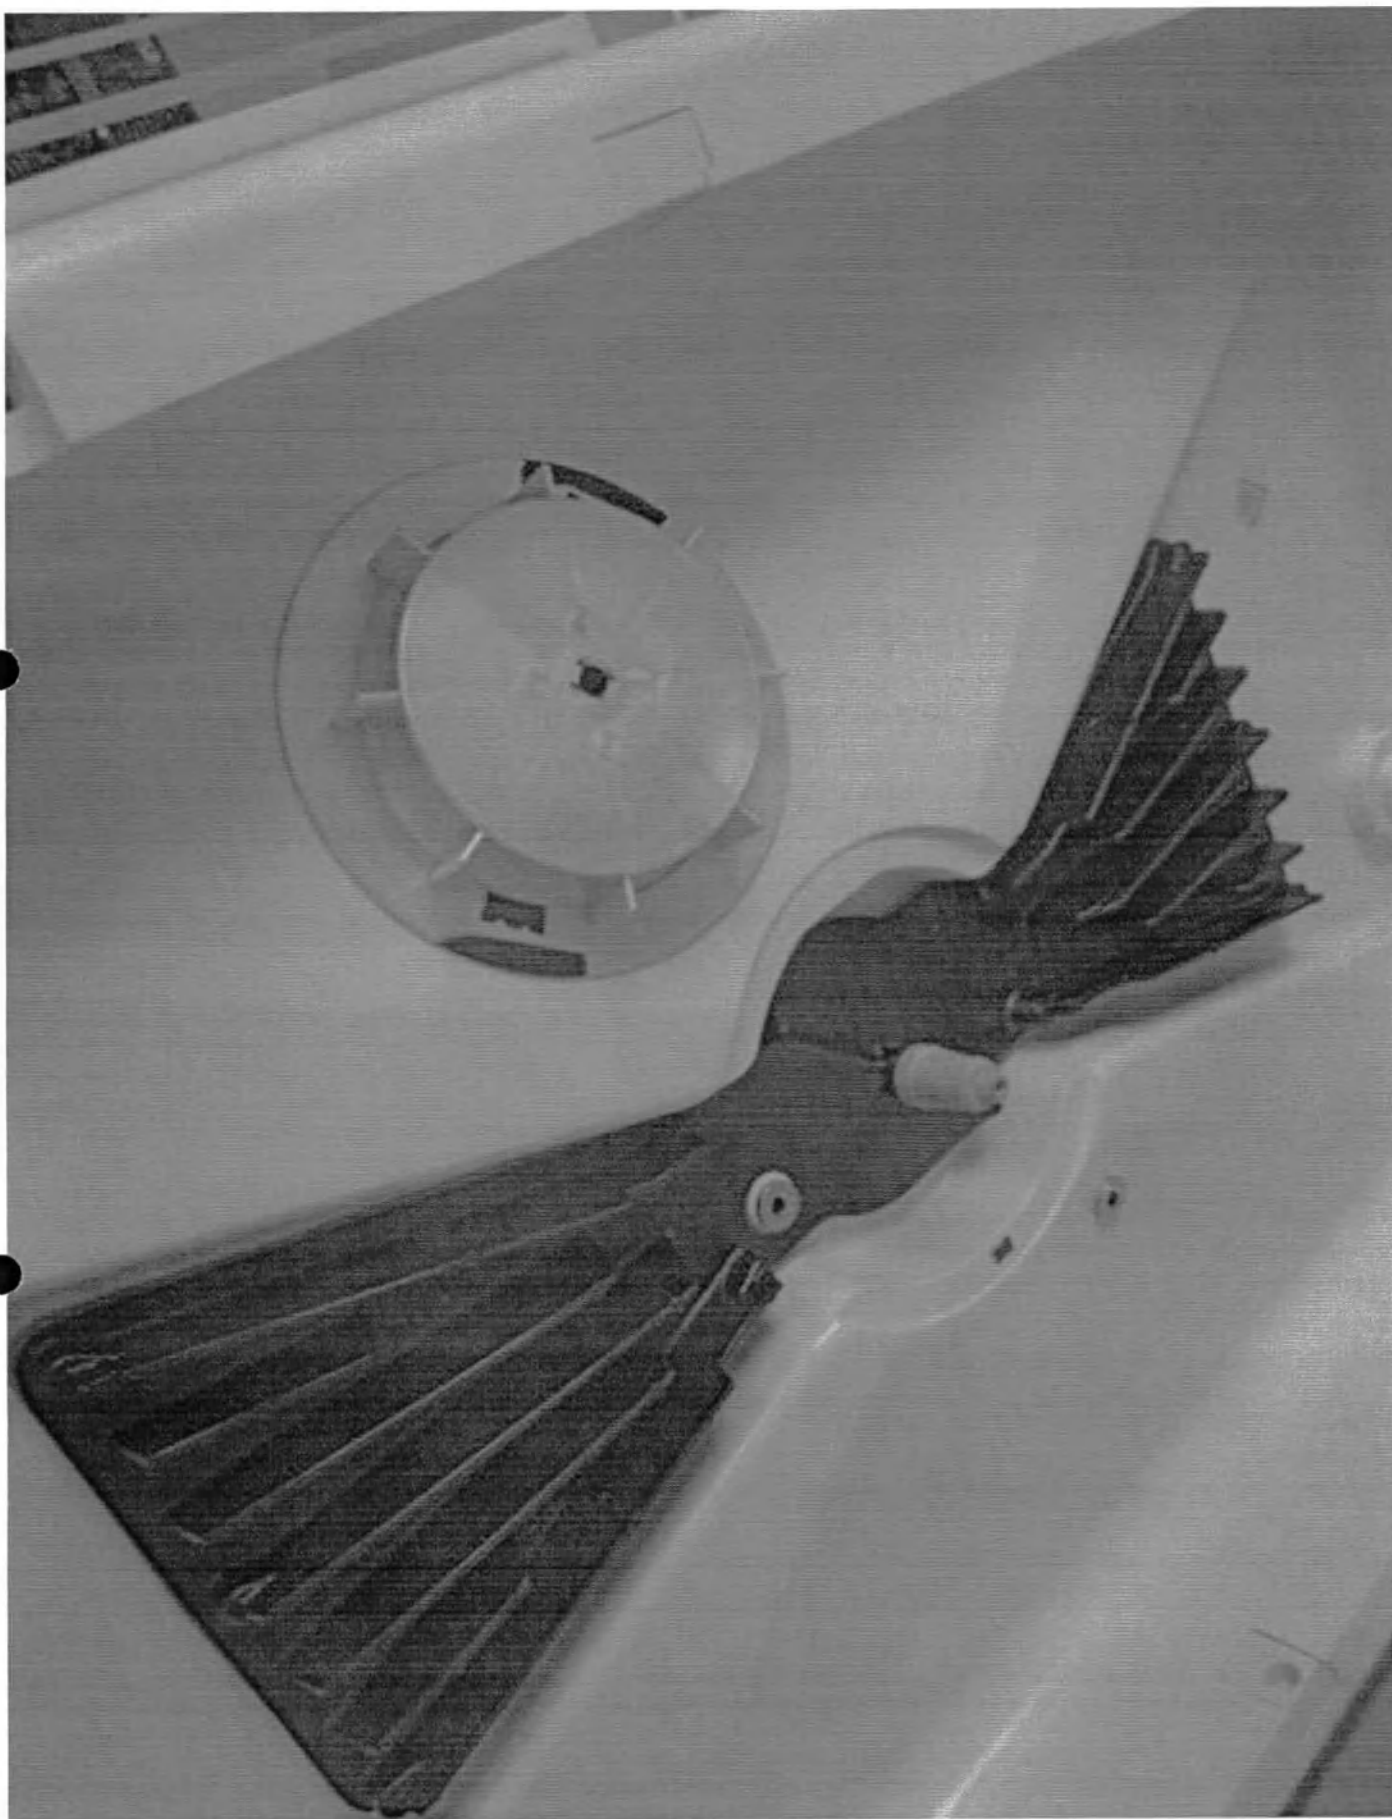

27. Корзина для принадлежностей с креплением «ласточкин хвост».

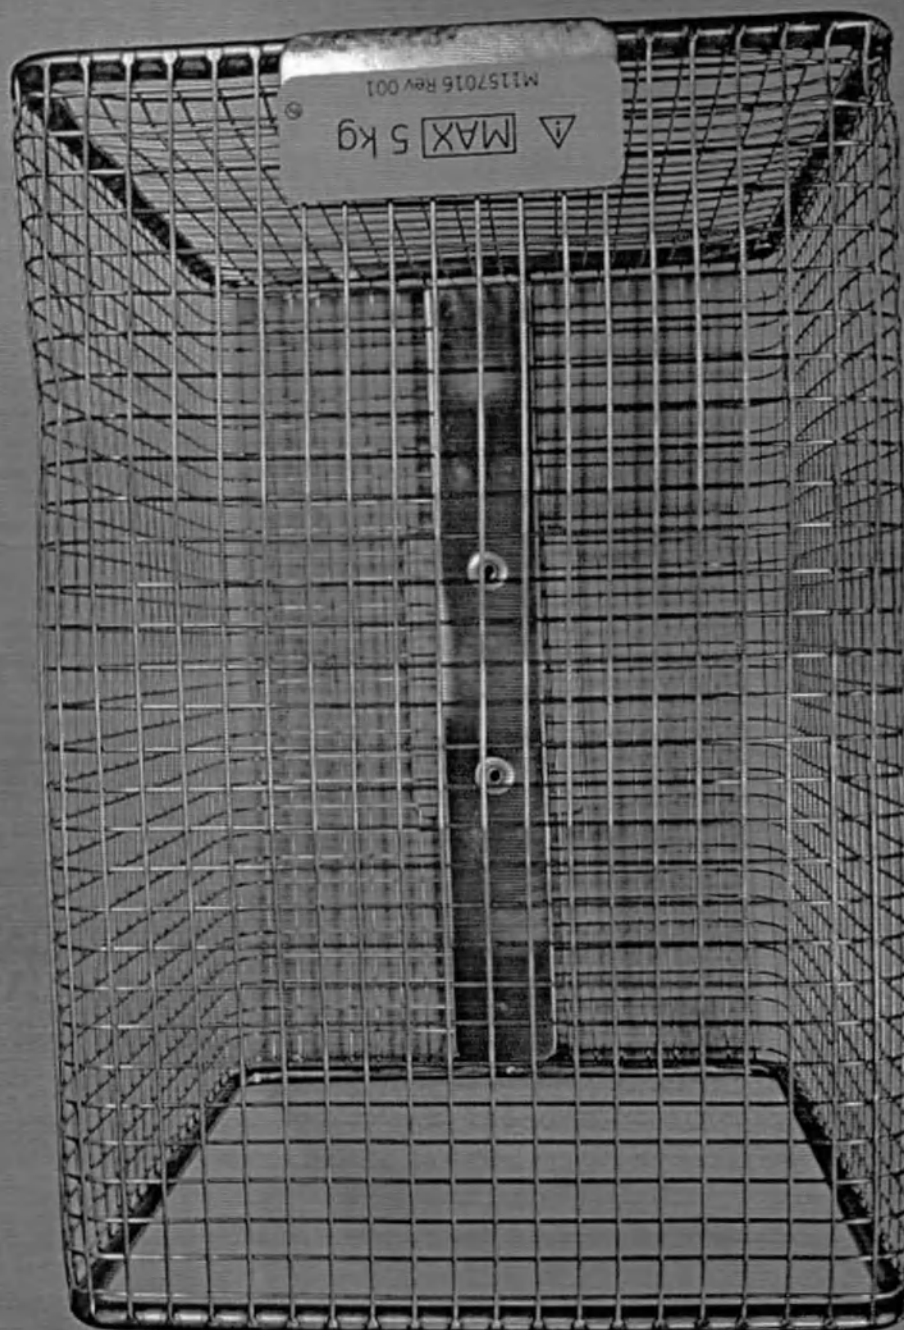


28. Устройство для автономного питания и перемещения.




29. Лампы экзаменационные, варианты исполнения:

29.1. Светодиодные с подключением к розетке, СЕ не более 10 шт.,




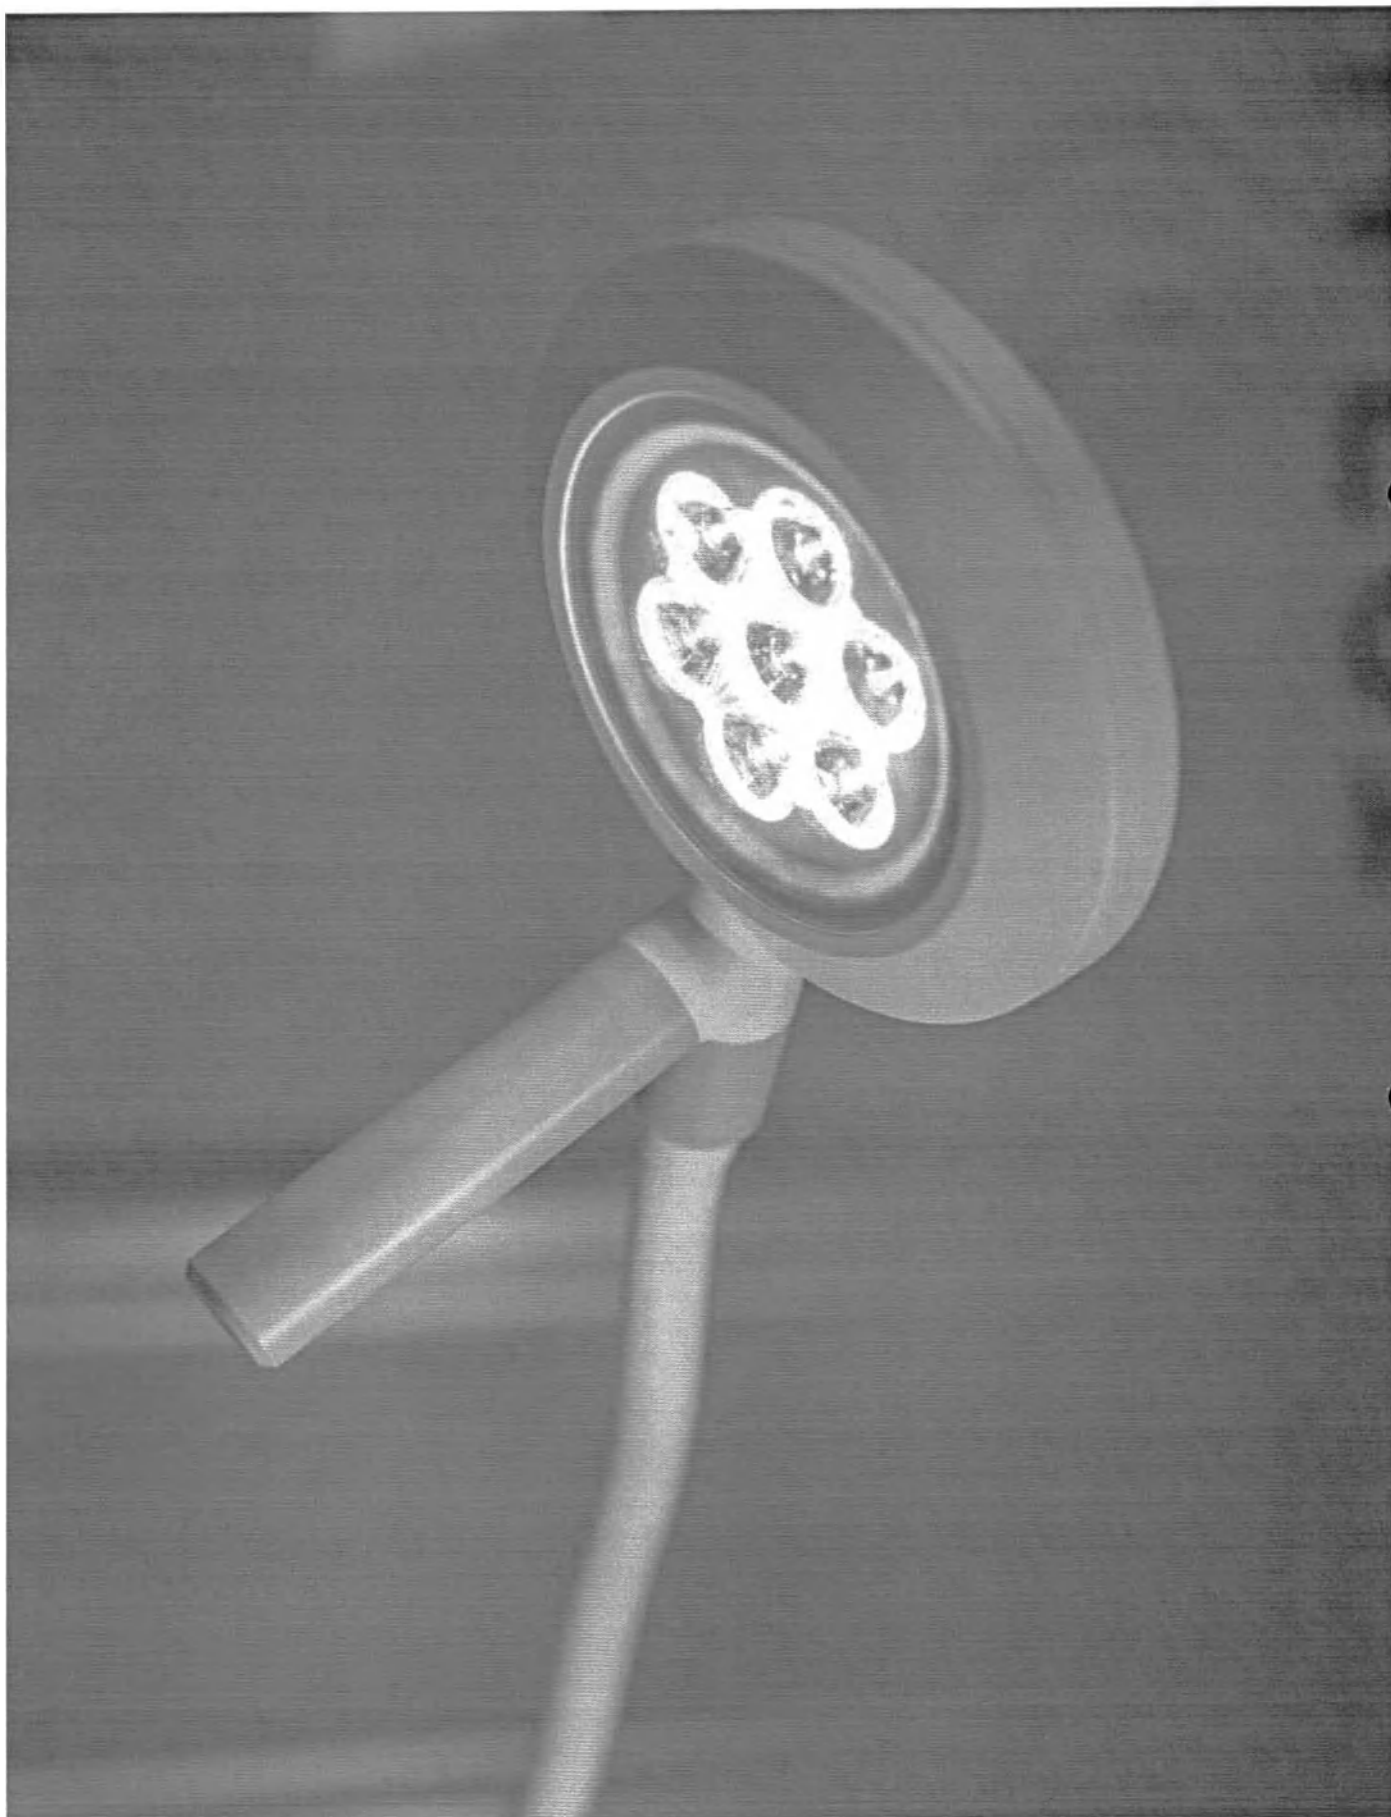

29.2.Светодиодные с подключением к аппарату, ИЕС не более 10 шт.

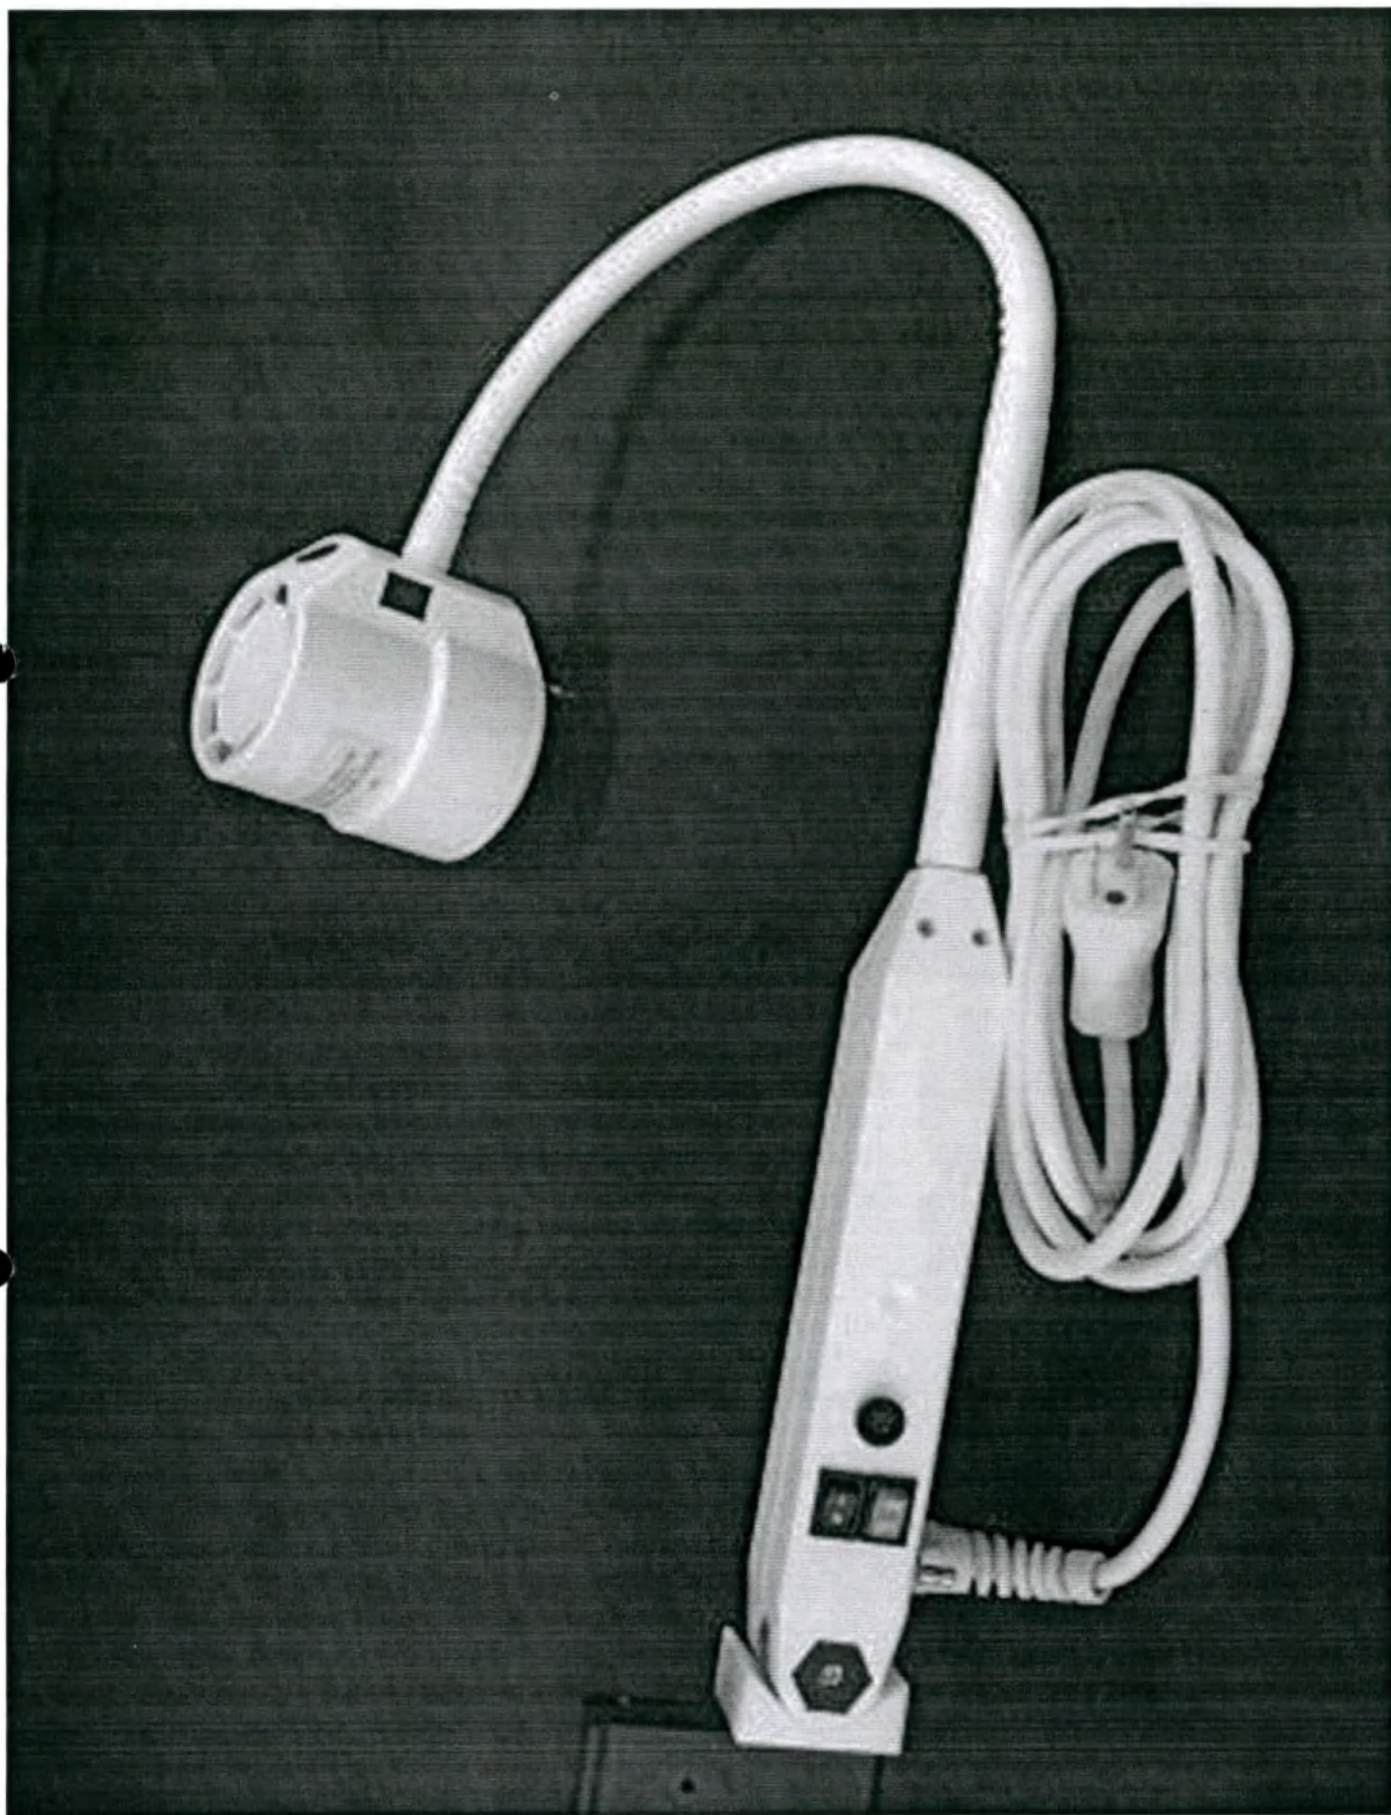




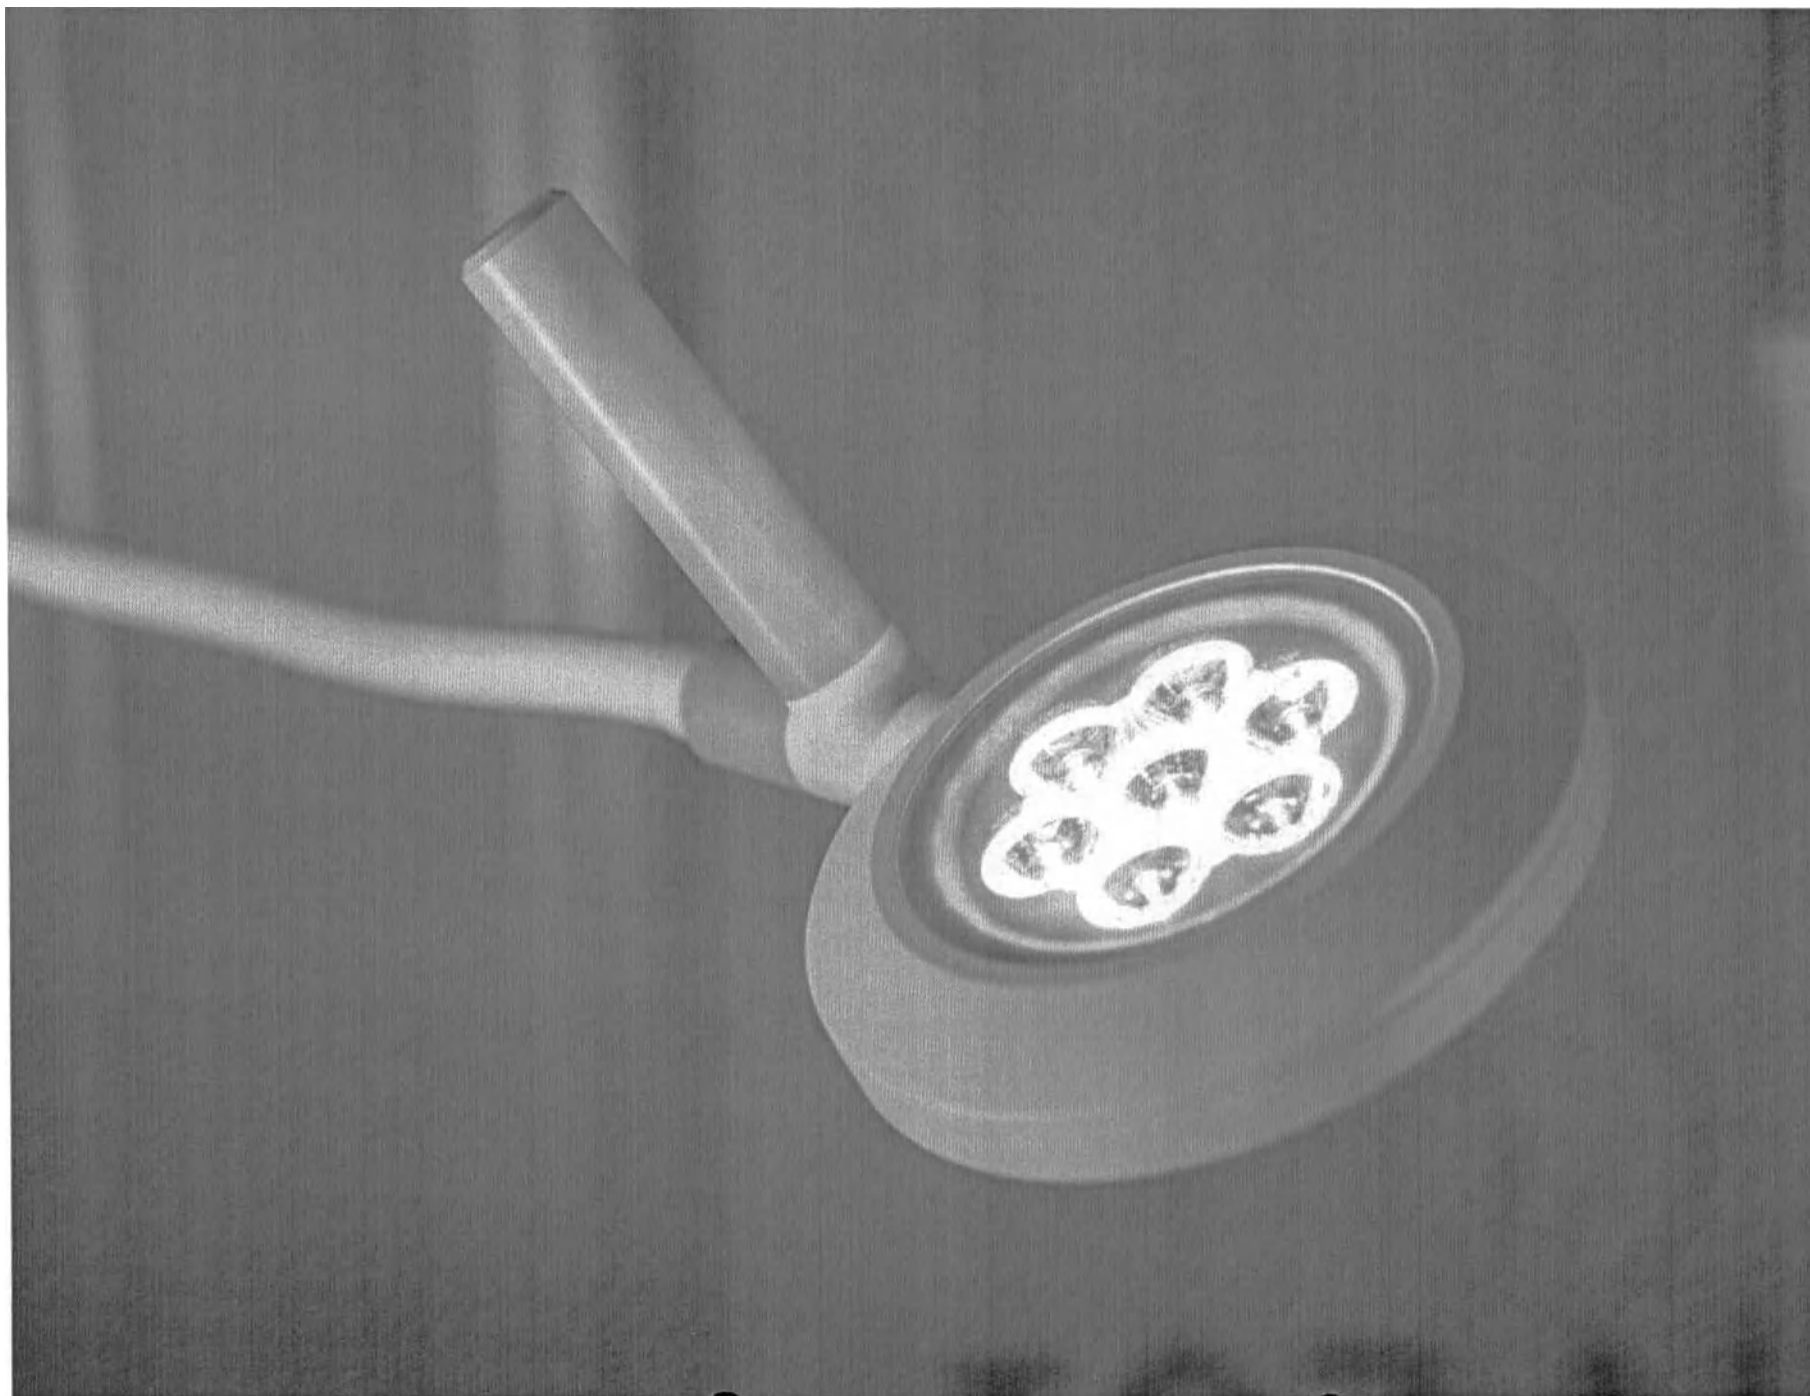

30. Манжеты ирисовые для дверец инкубатора, не более 100 шт.



31. Матрасики с распределением веса тела, не более 5 шт.

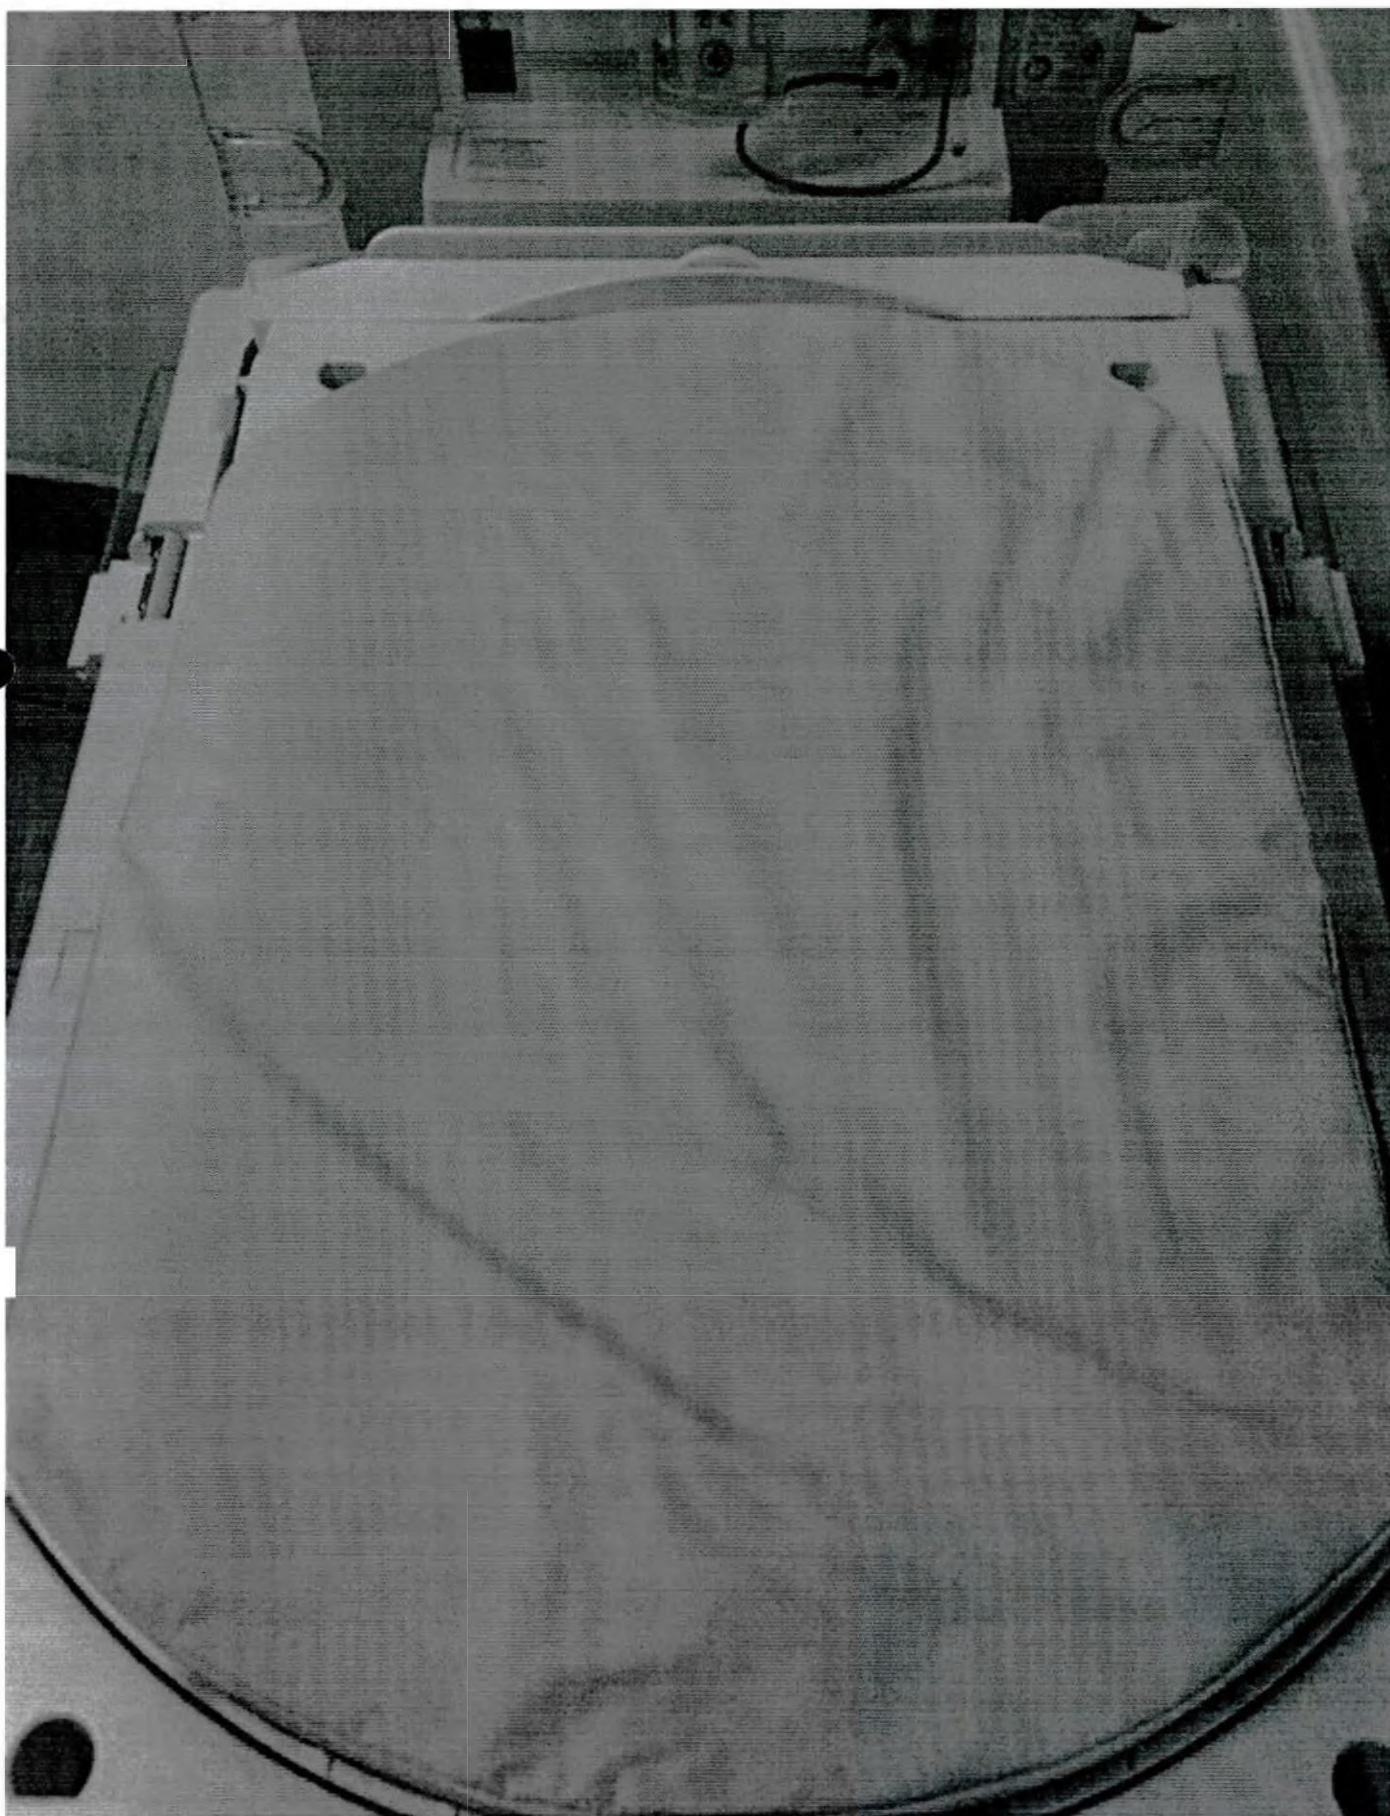


32. Покрывала защитные для матрасика с распределением веса тела, не более 5 шт.





33. Чехлы защитные для матрасика с распределением веса тела, не более 5 шт.

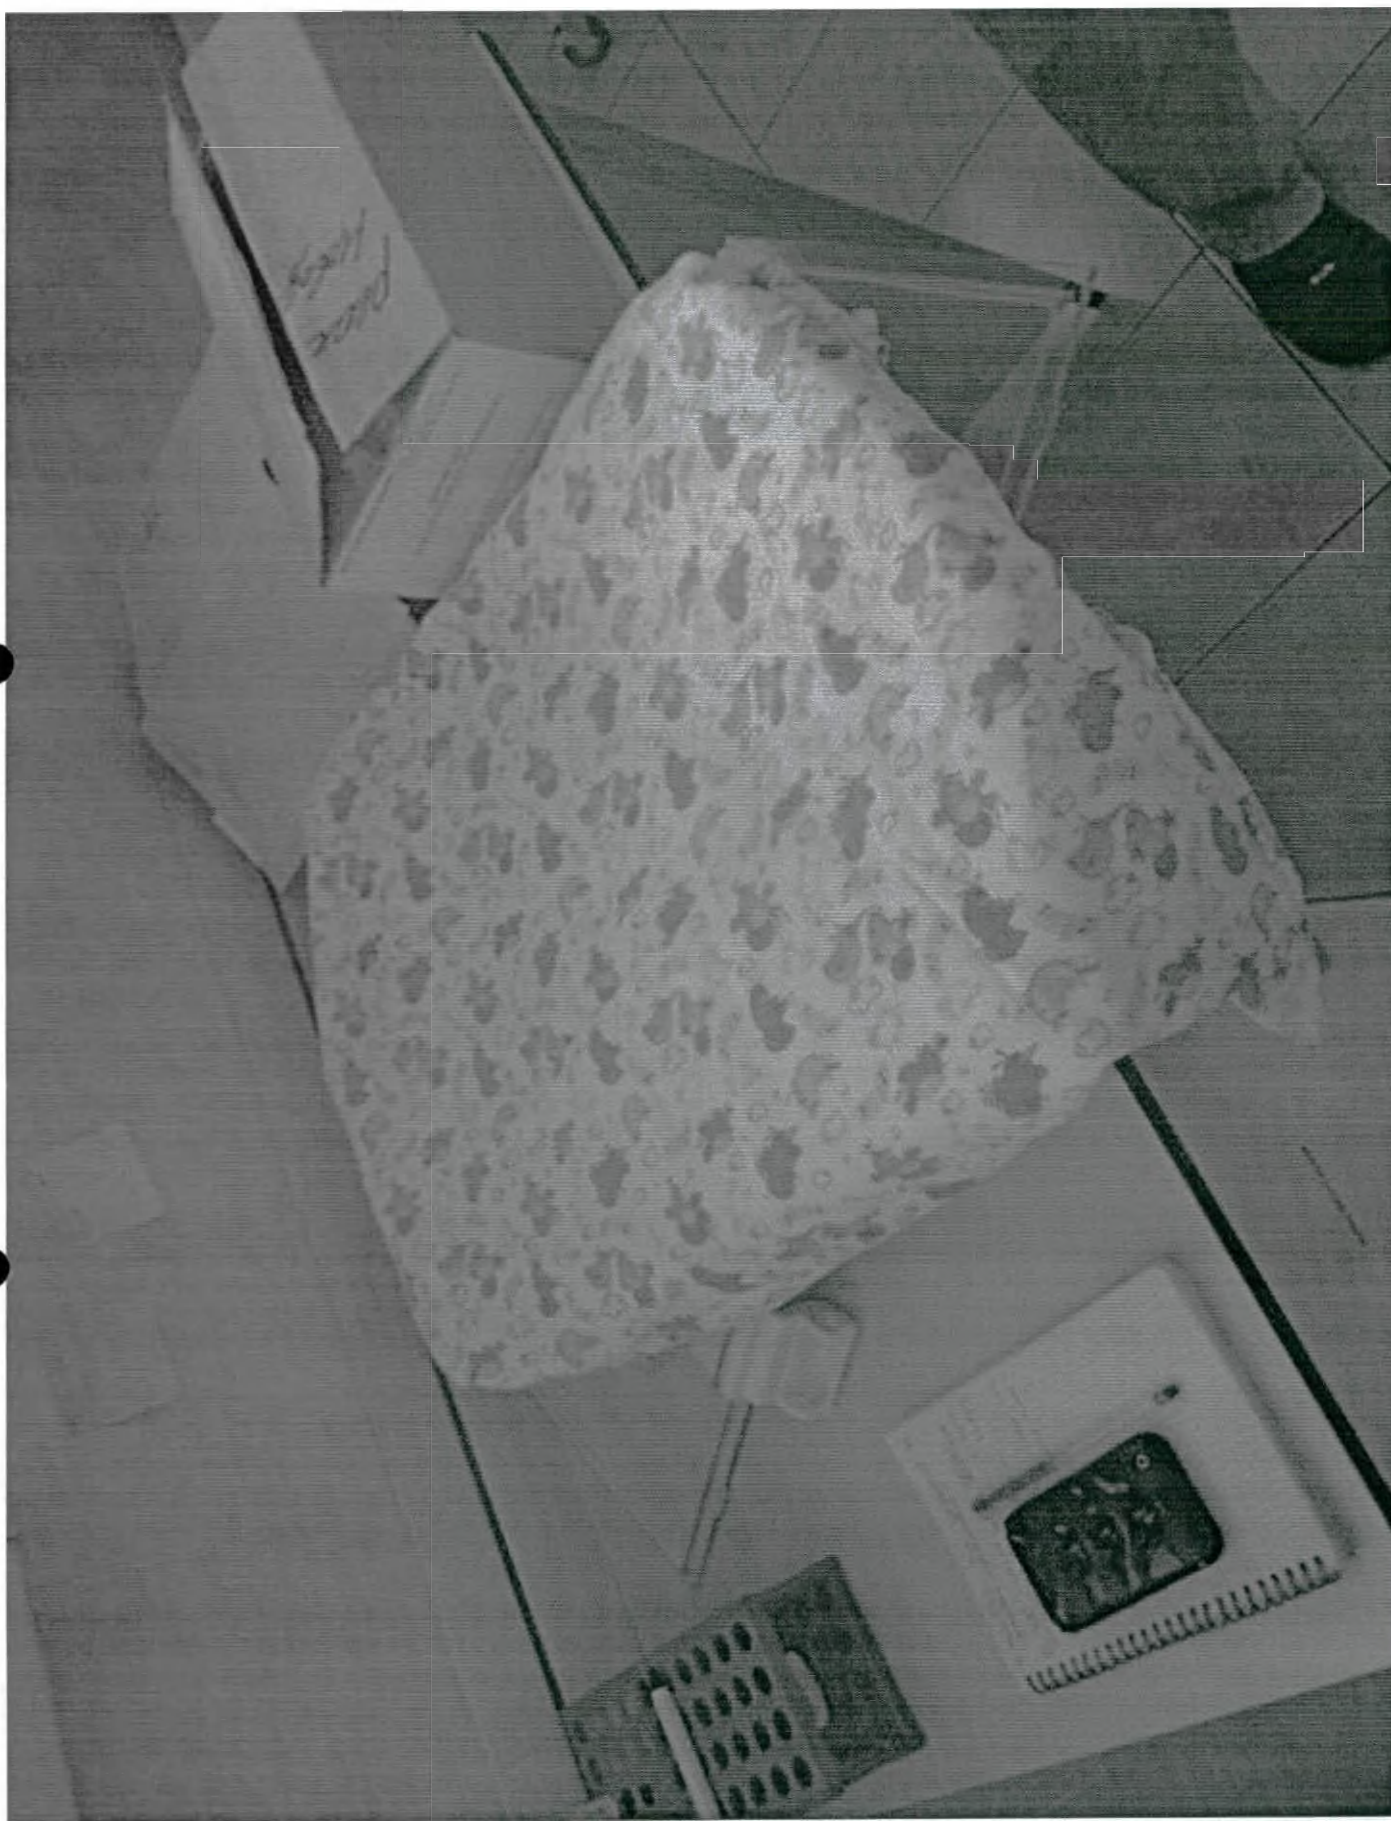

34. Лотки угловые в вариантах исполнения:


34.1. Угловые лотки (нижний правый и верхний левый), не более 5 шт.




34.2. Угловые лотки (нижний левый и верхний правый), не более 5 шт.



35. Лотки для рентген кассеты, не более 5 шт.

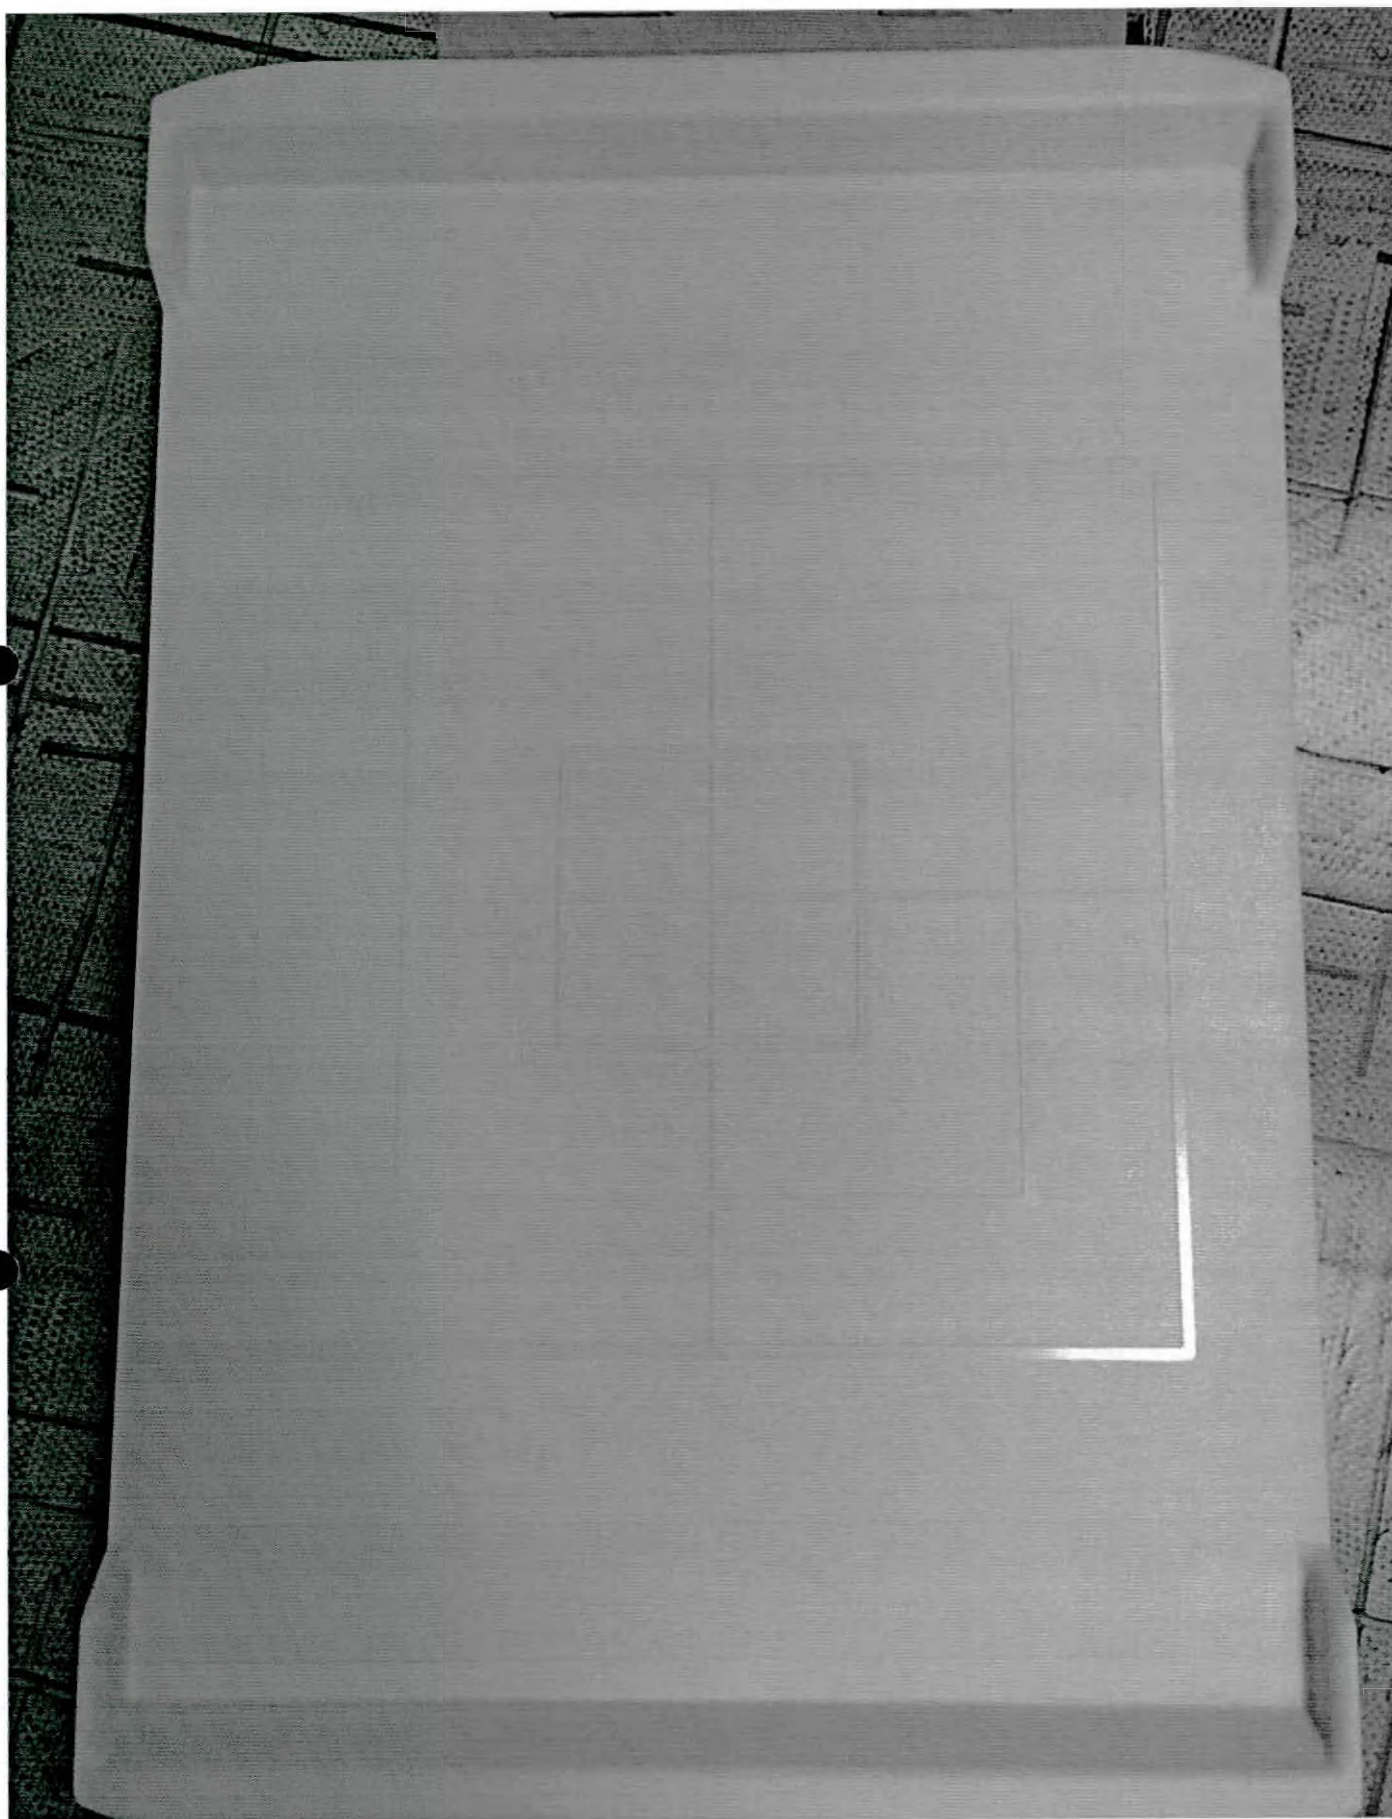


36. Полки мониторные, задние, не более 5 шт.

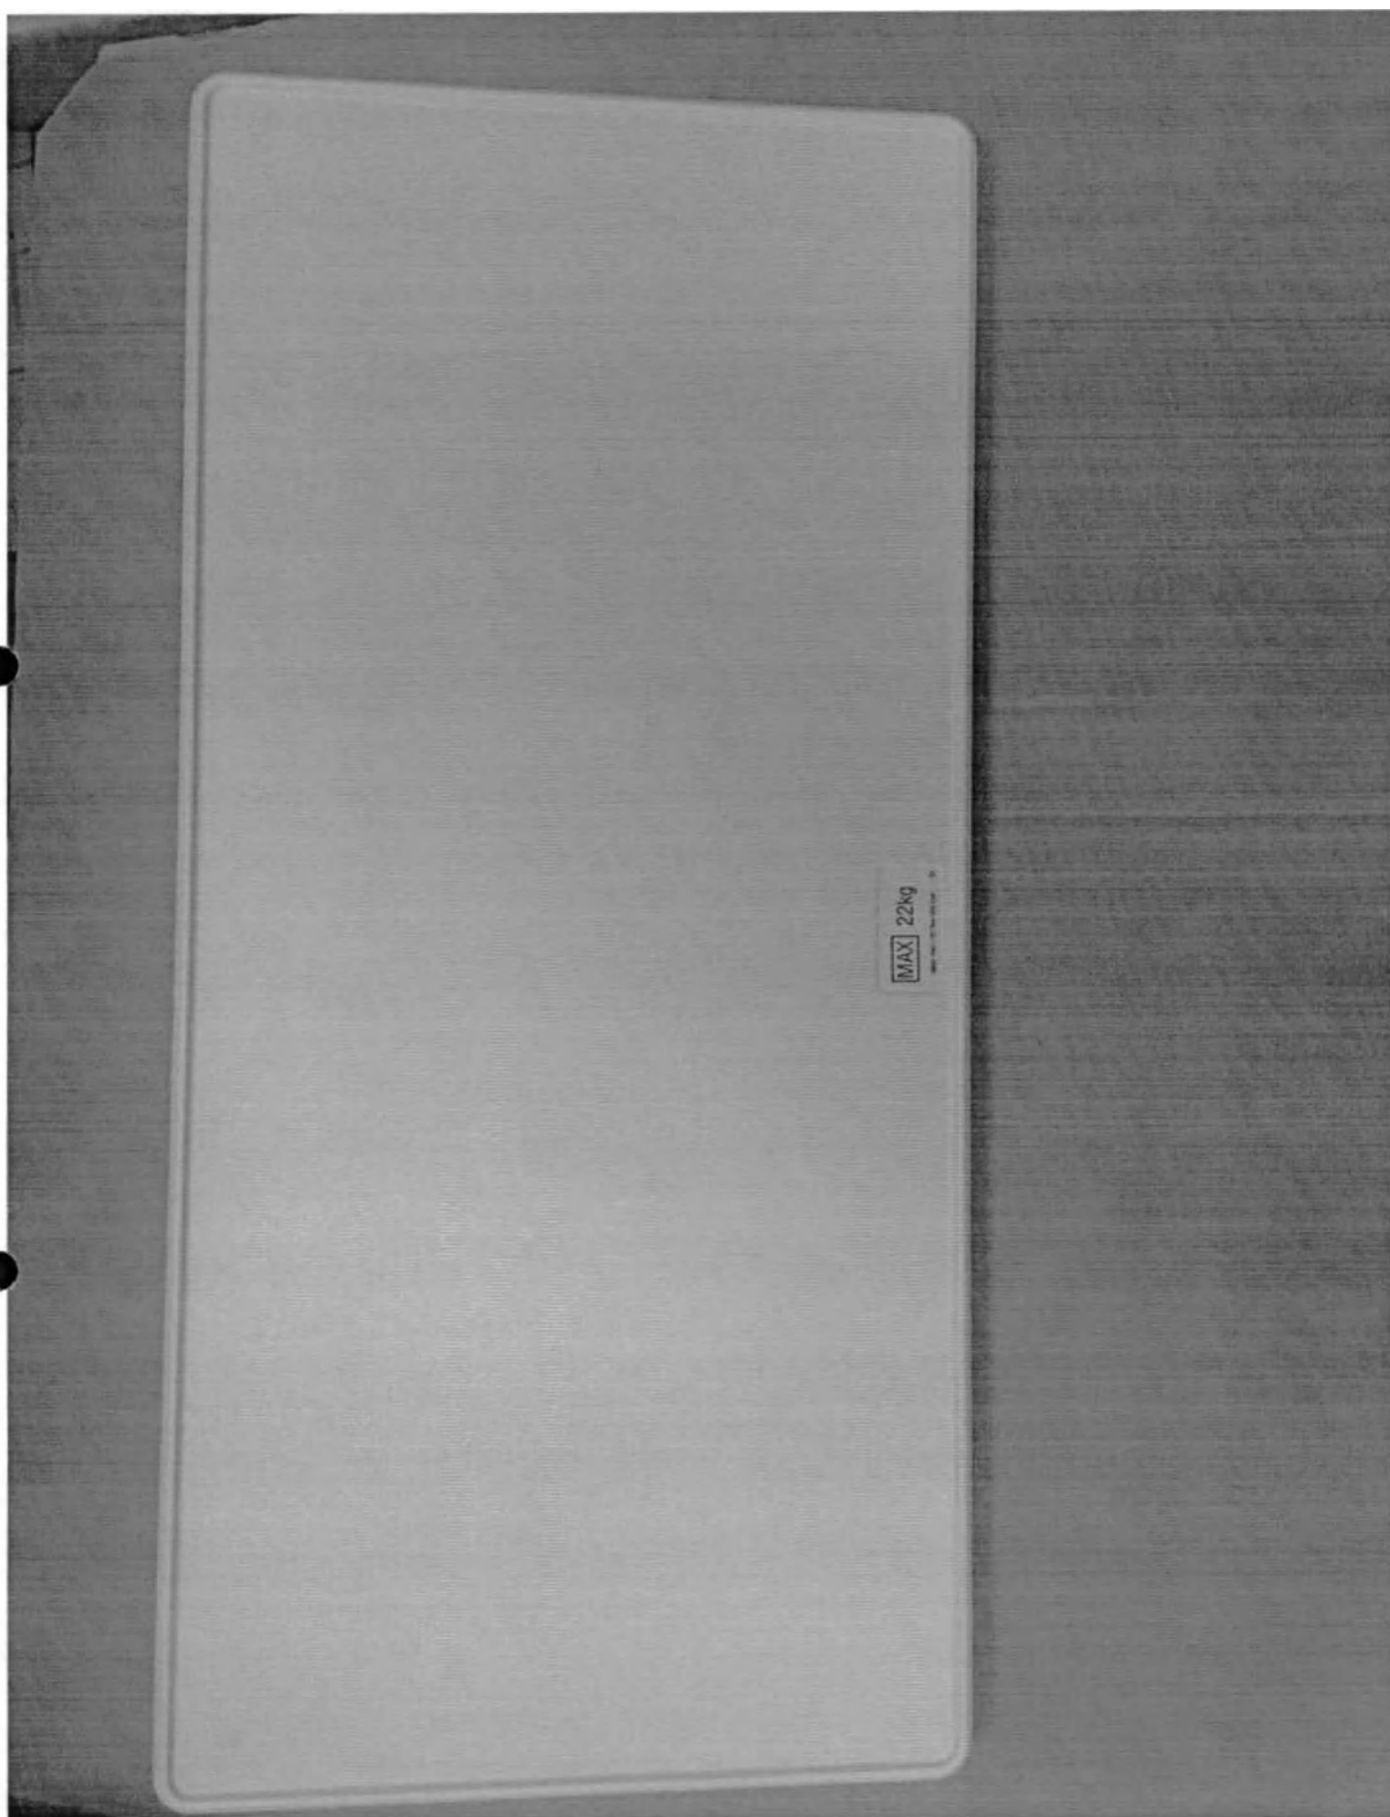


37. Полки инструментальные, шарнирные, для принадлежностей не более 5 шт.




38. Держатели трубок, с креплением возле ложа пациента не более 5 шт.

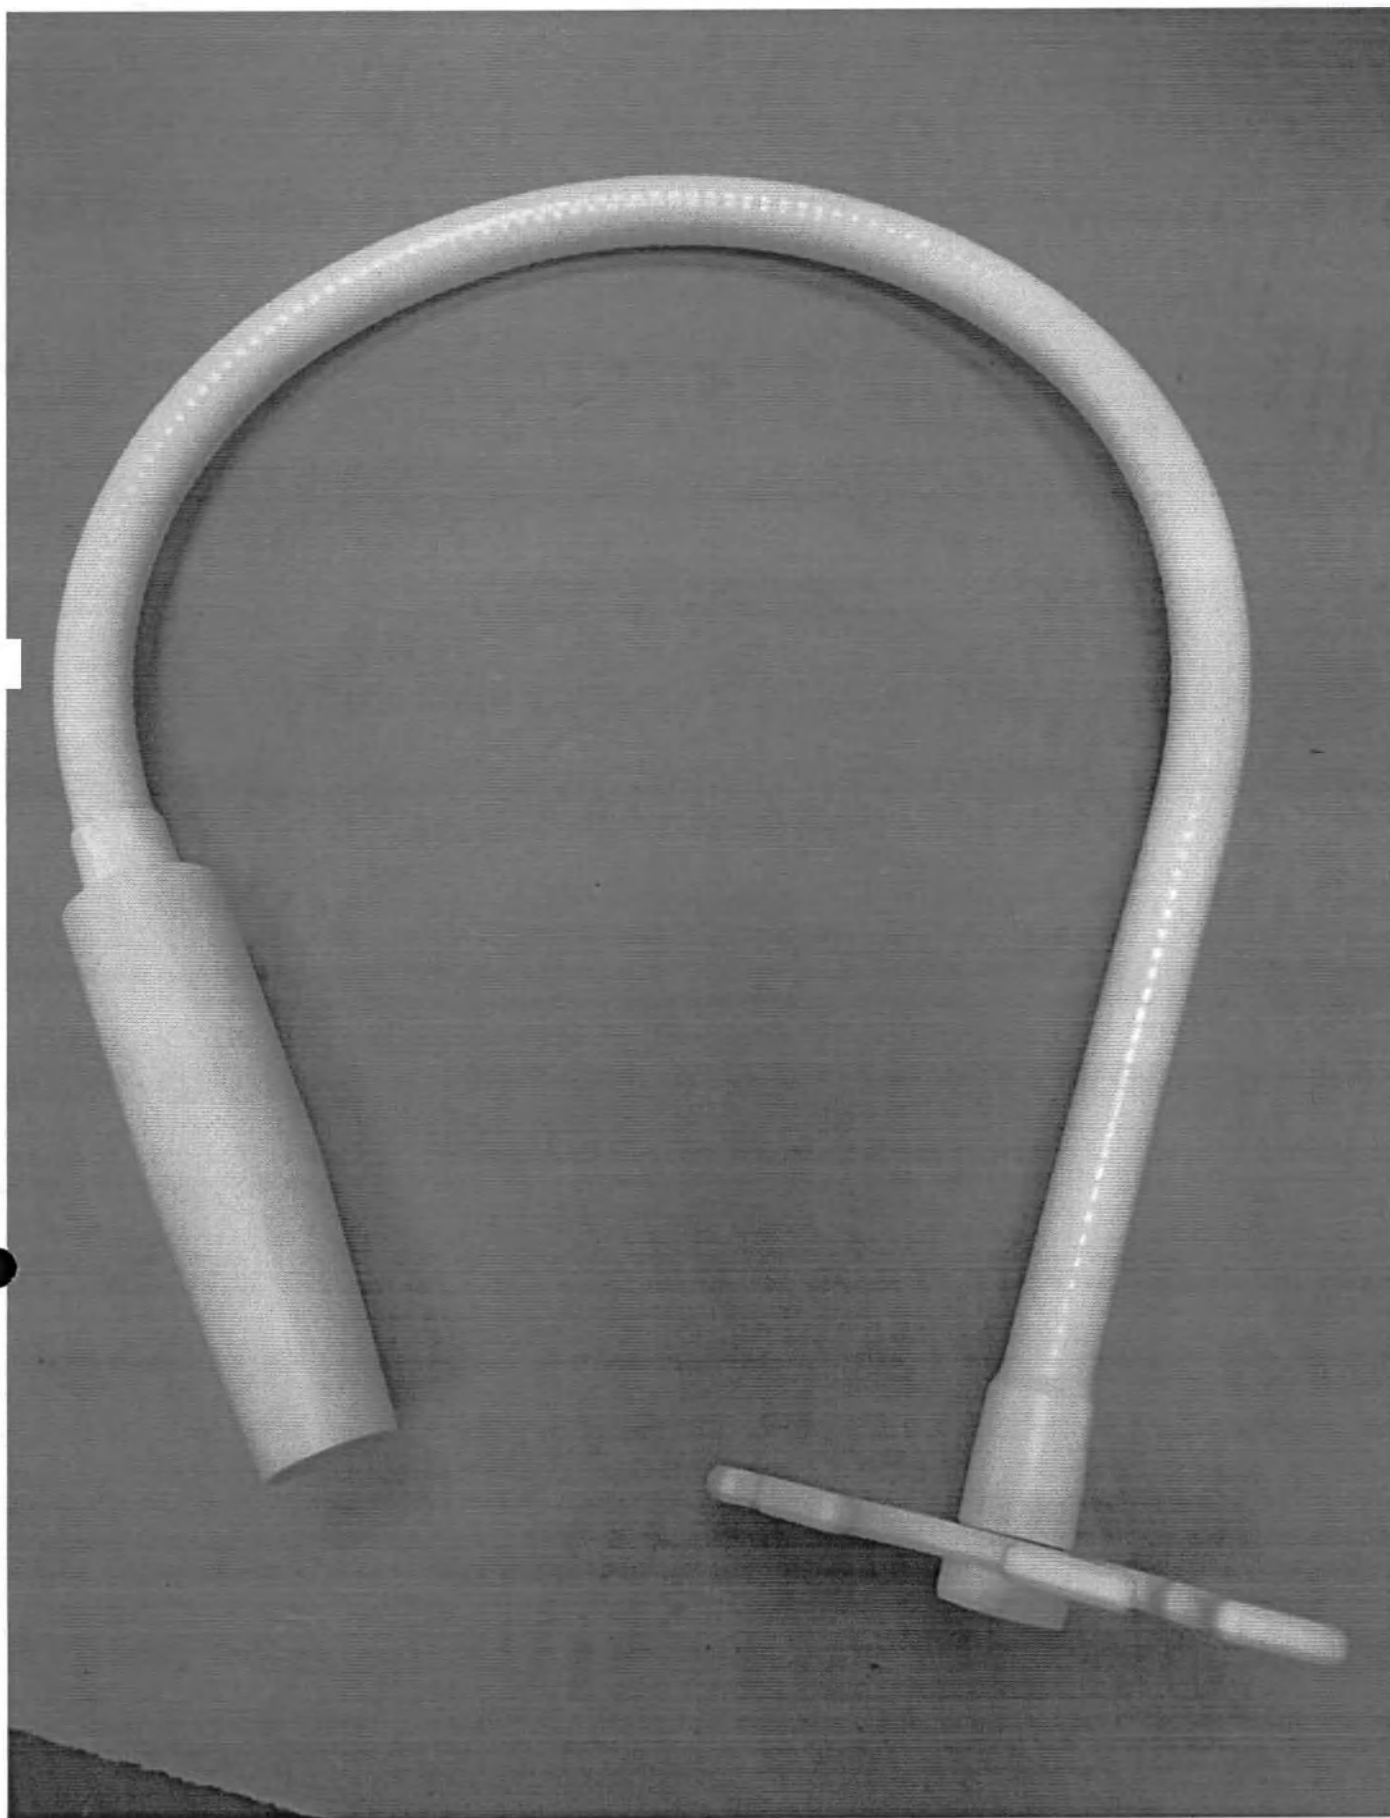


39. Кабели питания, не более 5 шт.

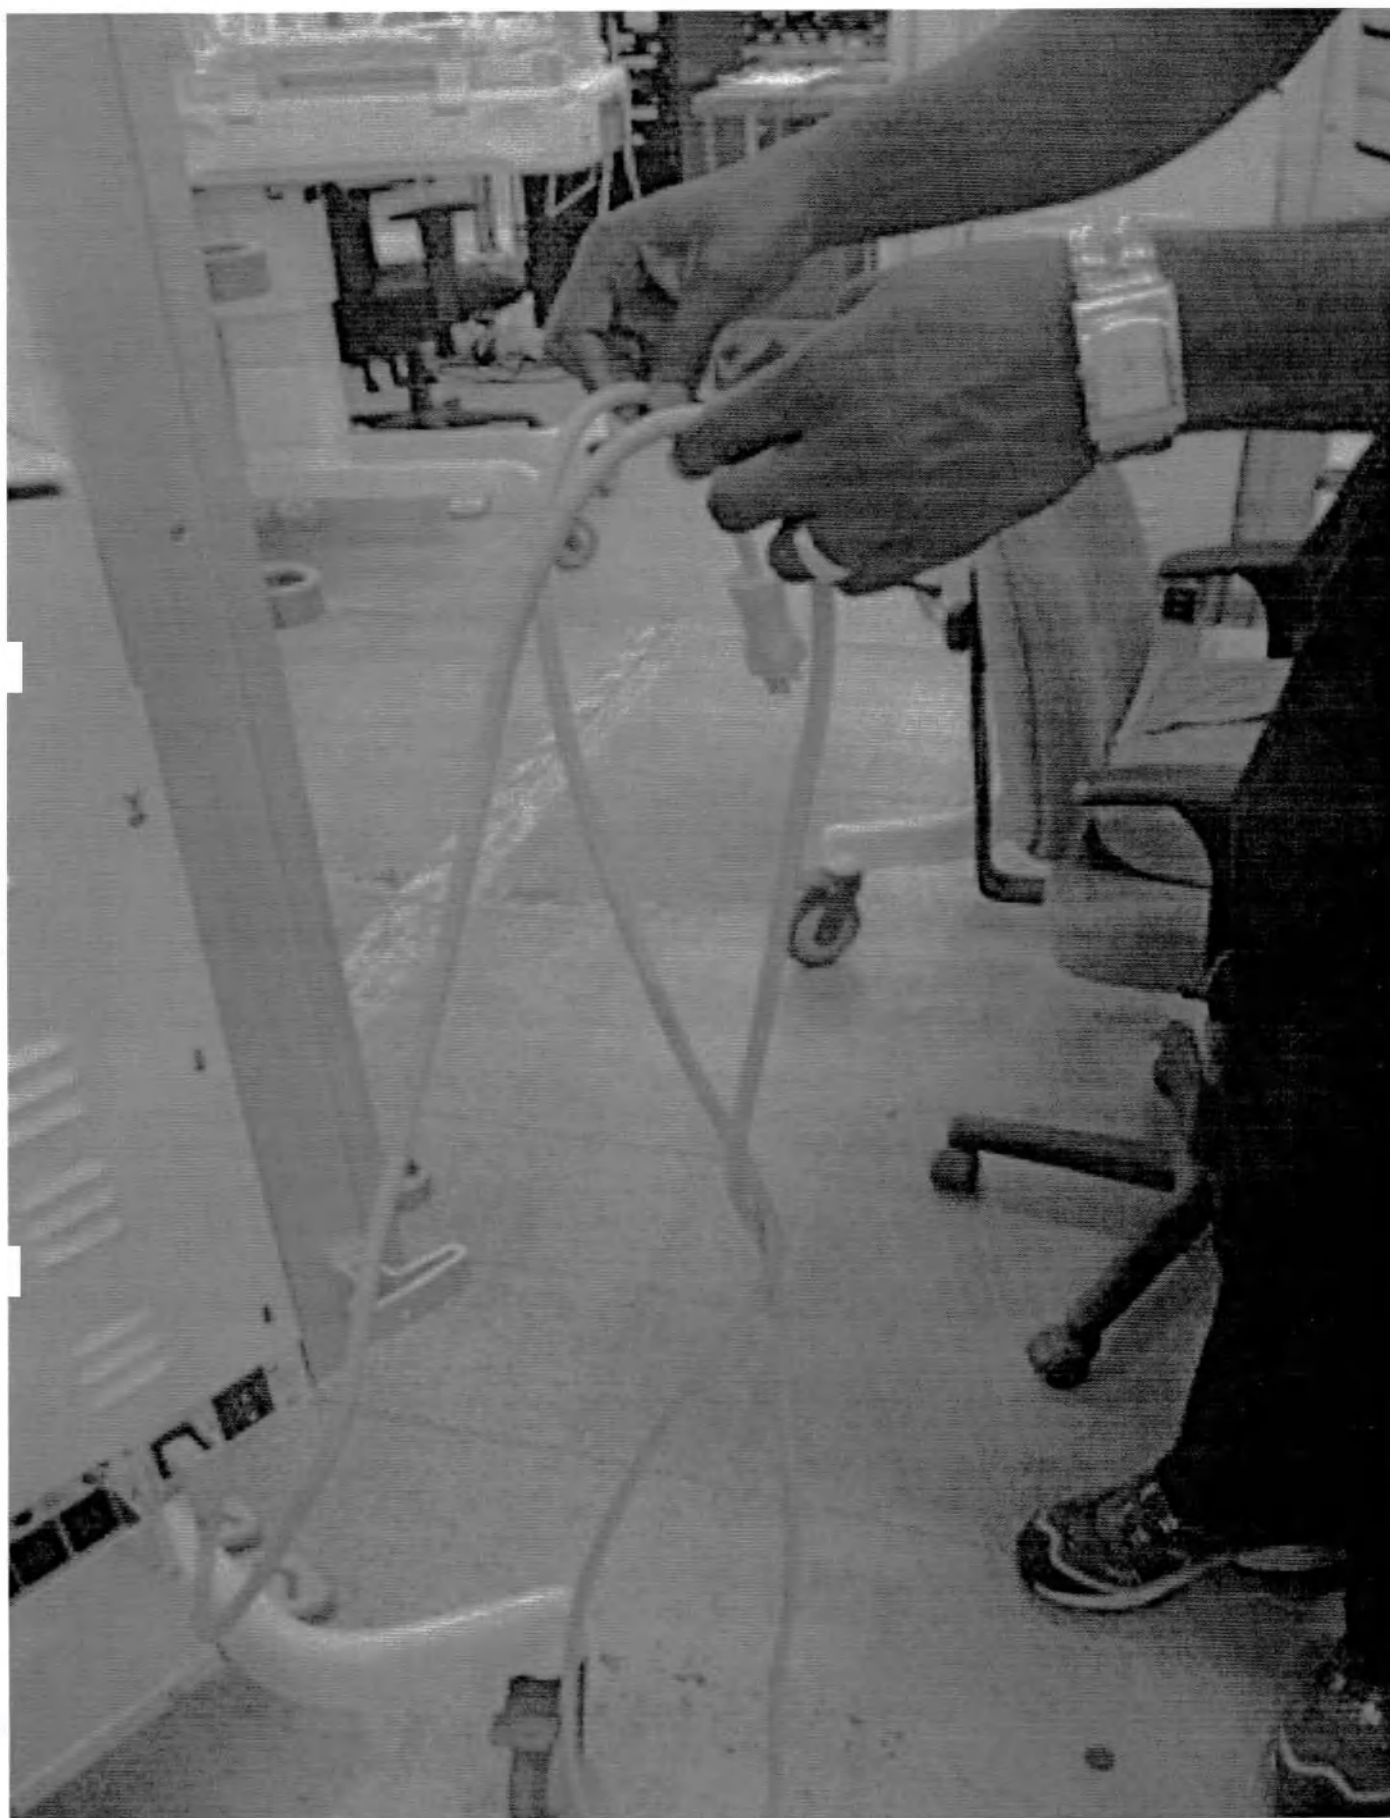


40. Крепеж для мешка.

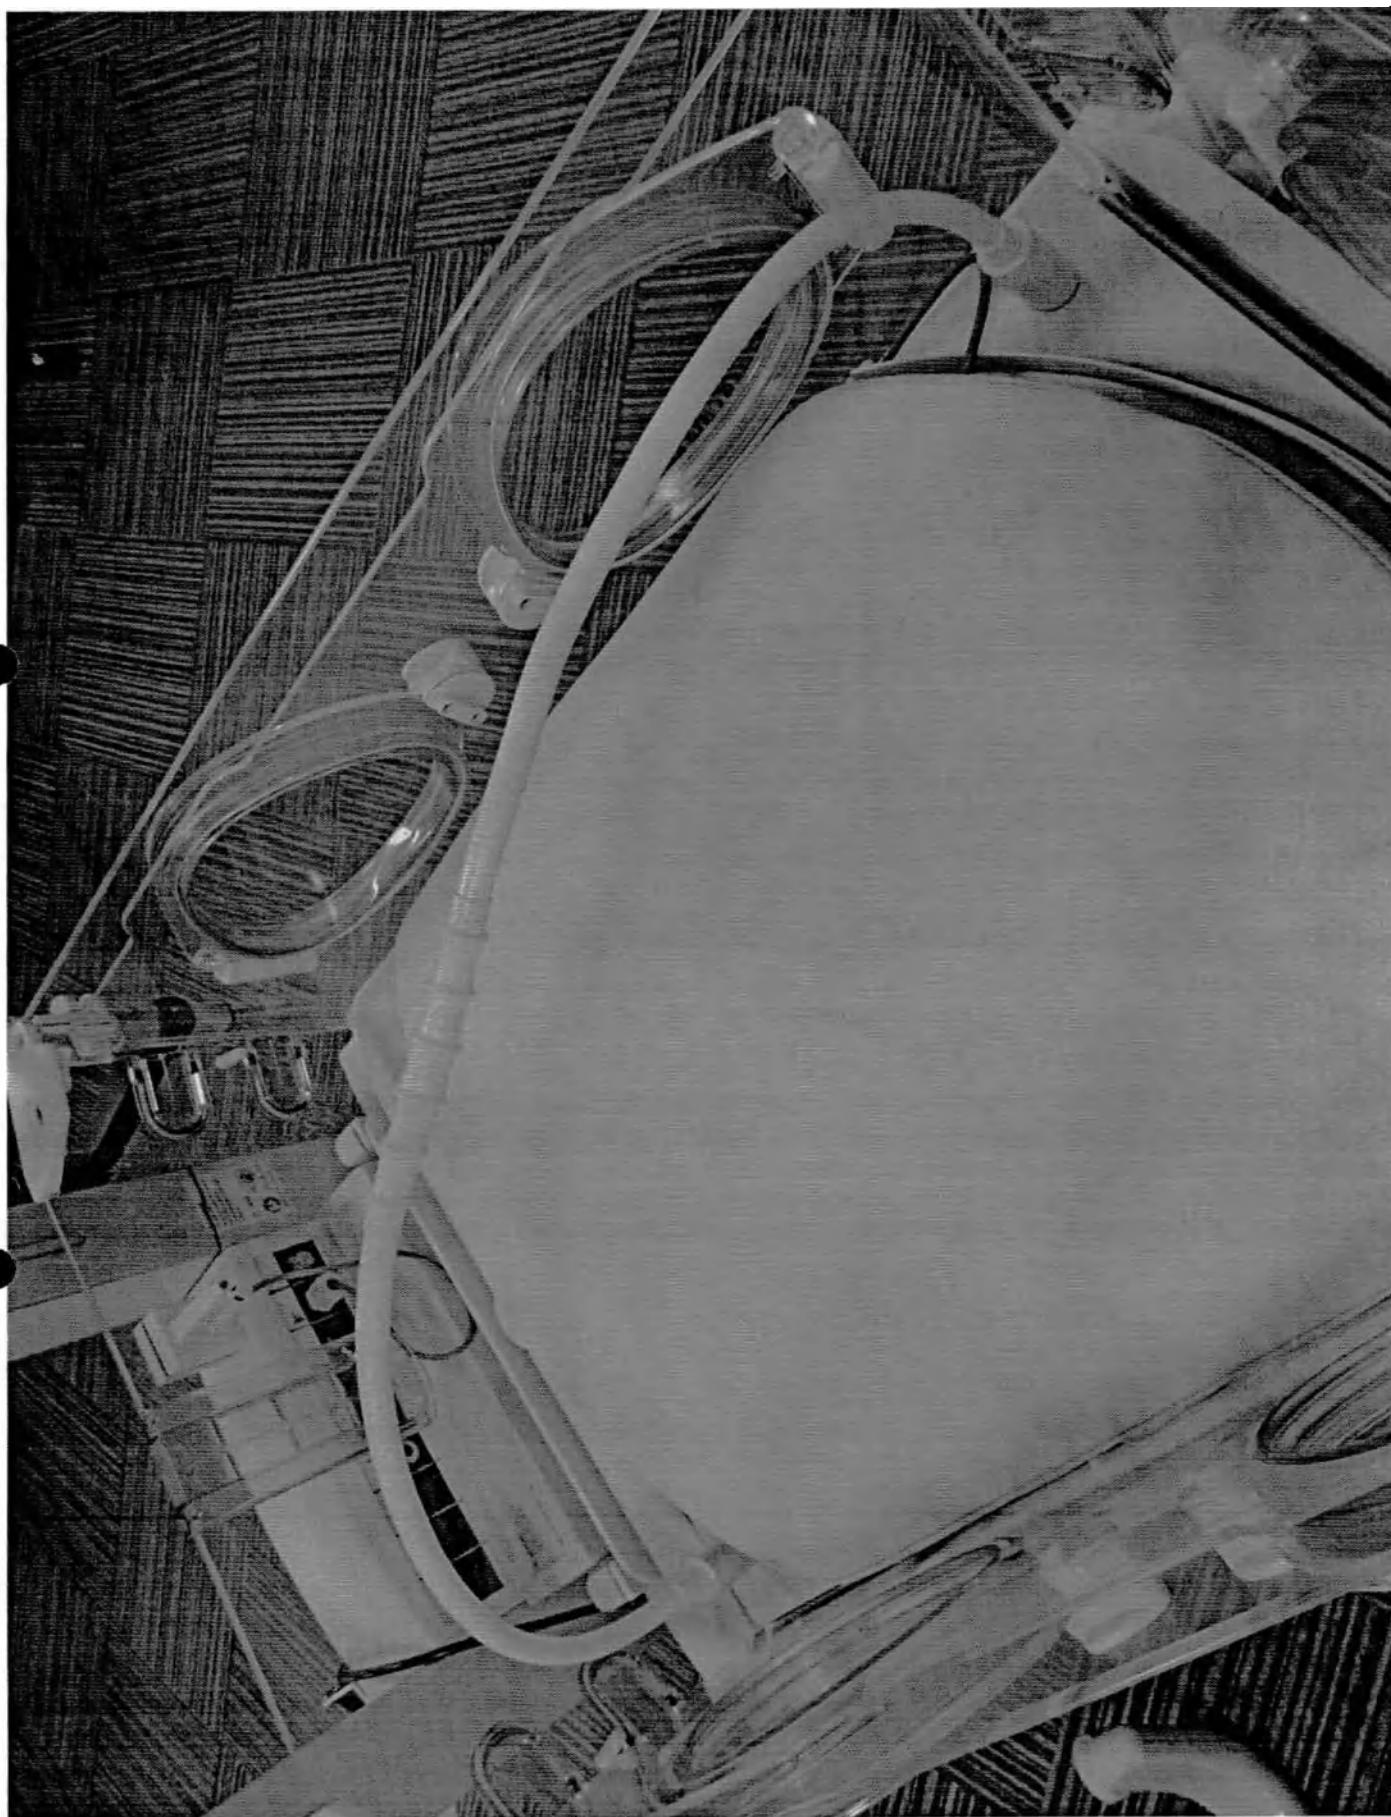


41. Шланги для кислорода с разъемами NIST/DIN, не более 10 шт.

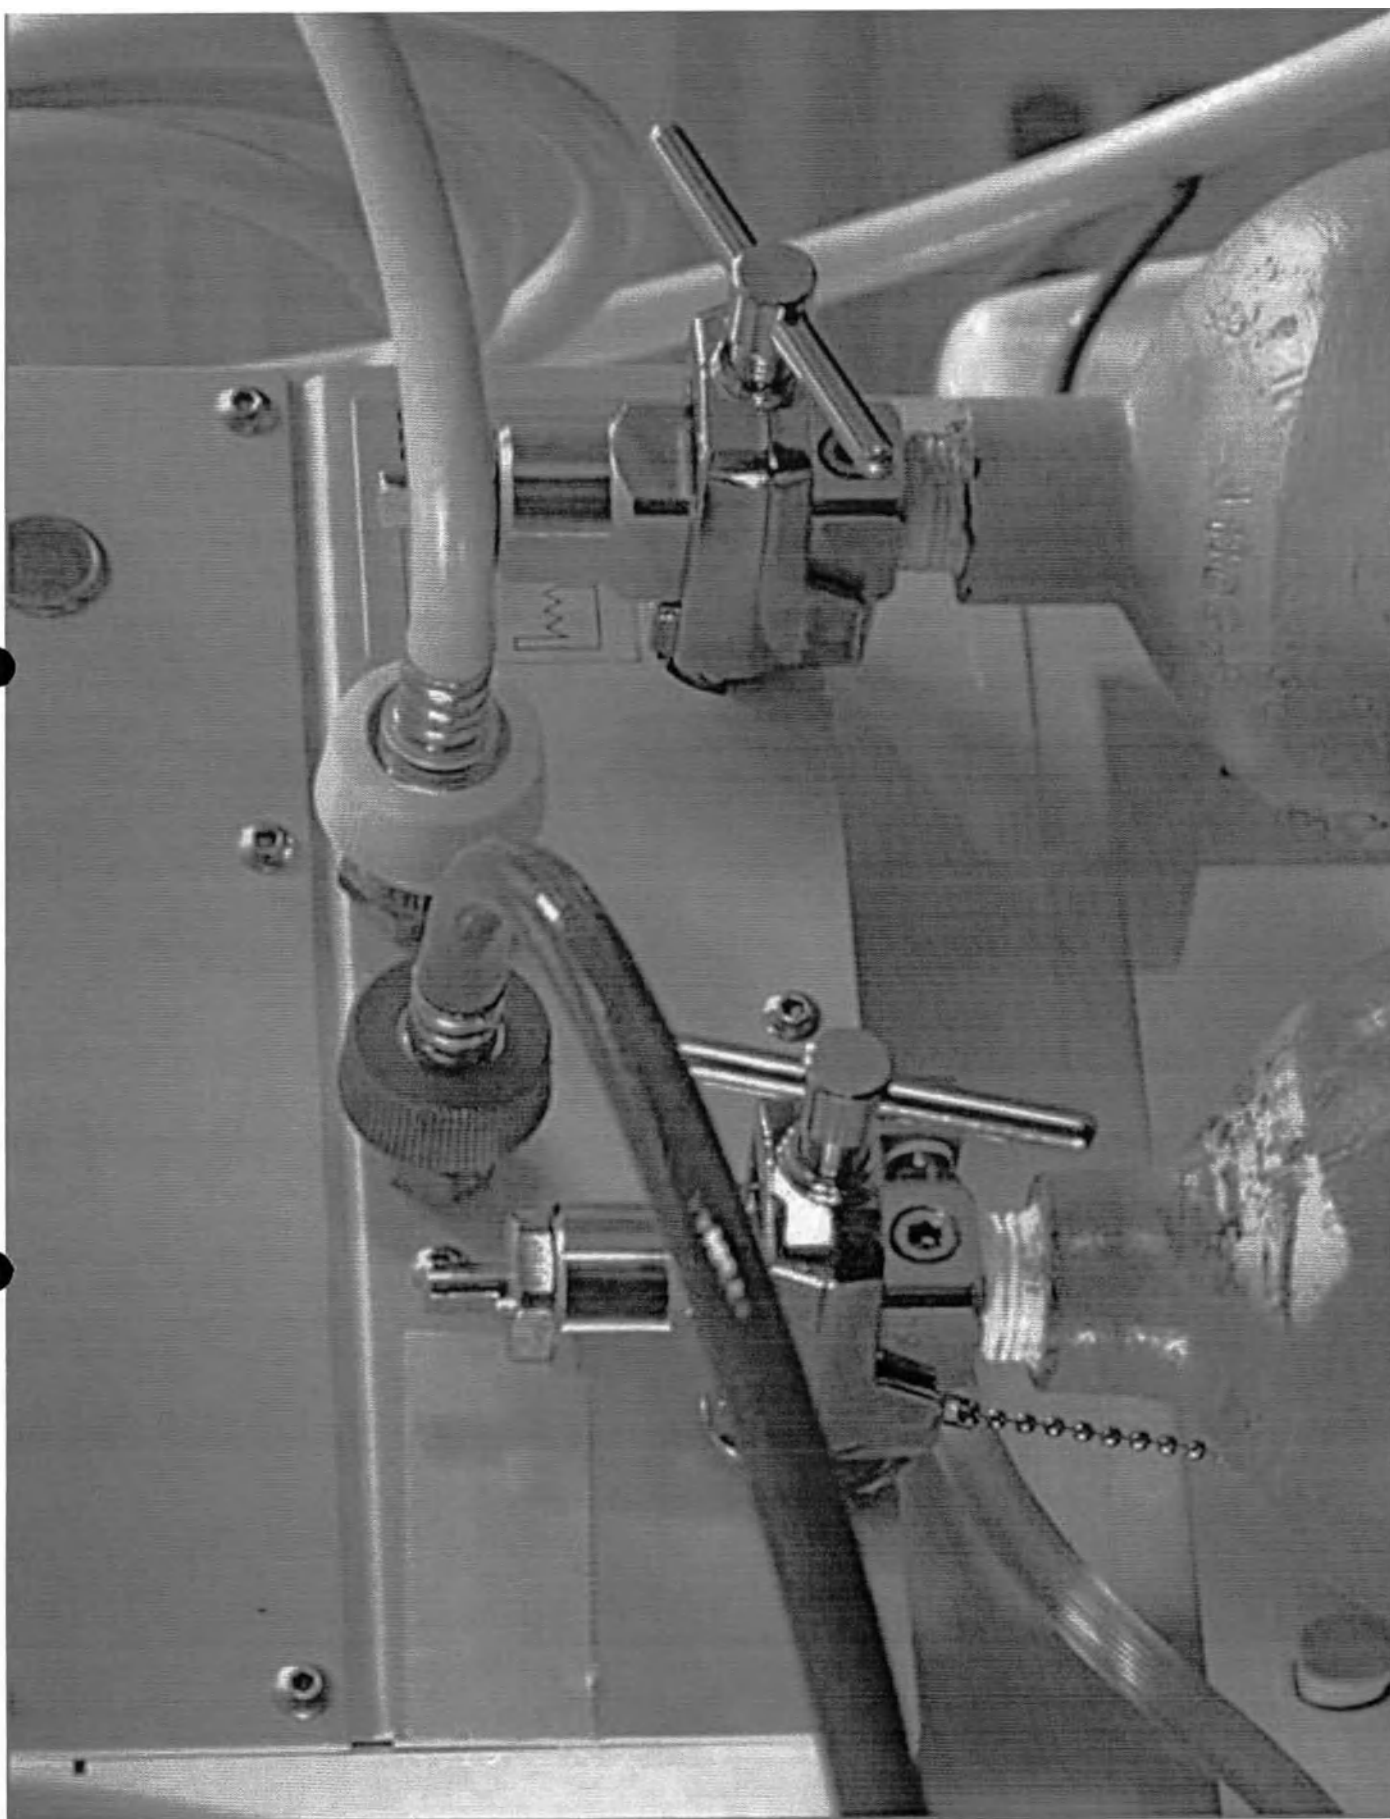

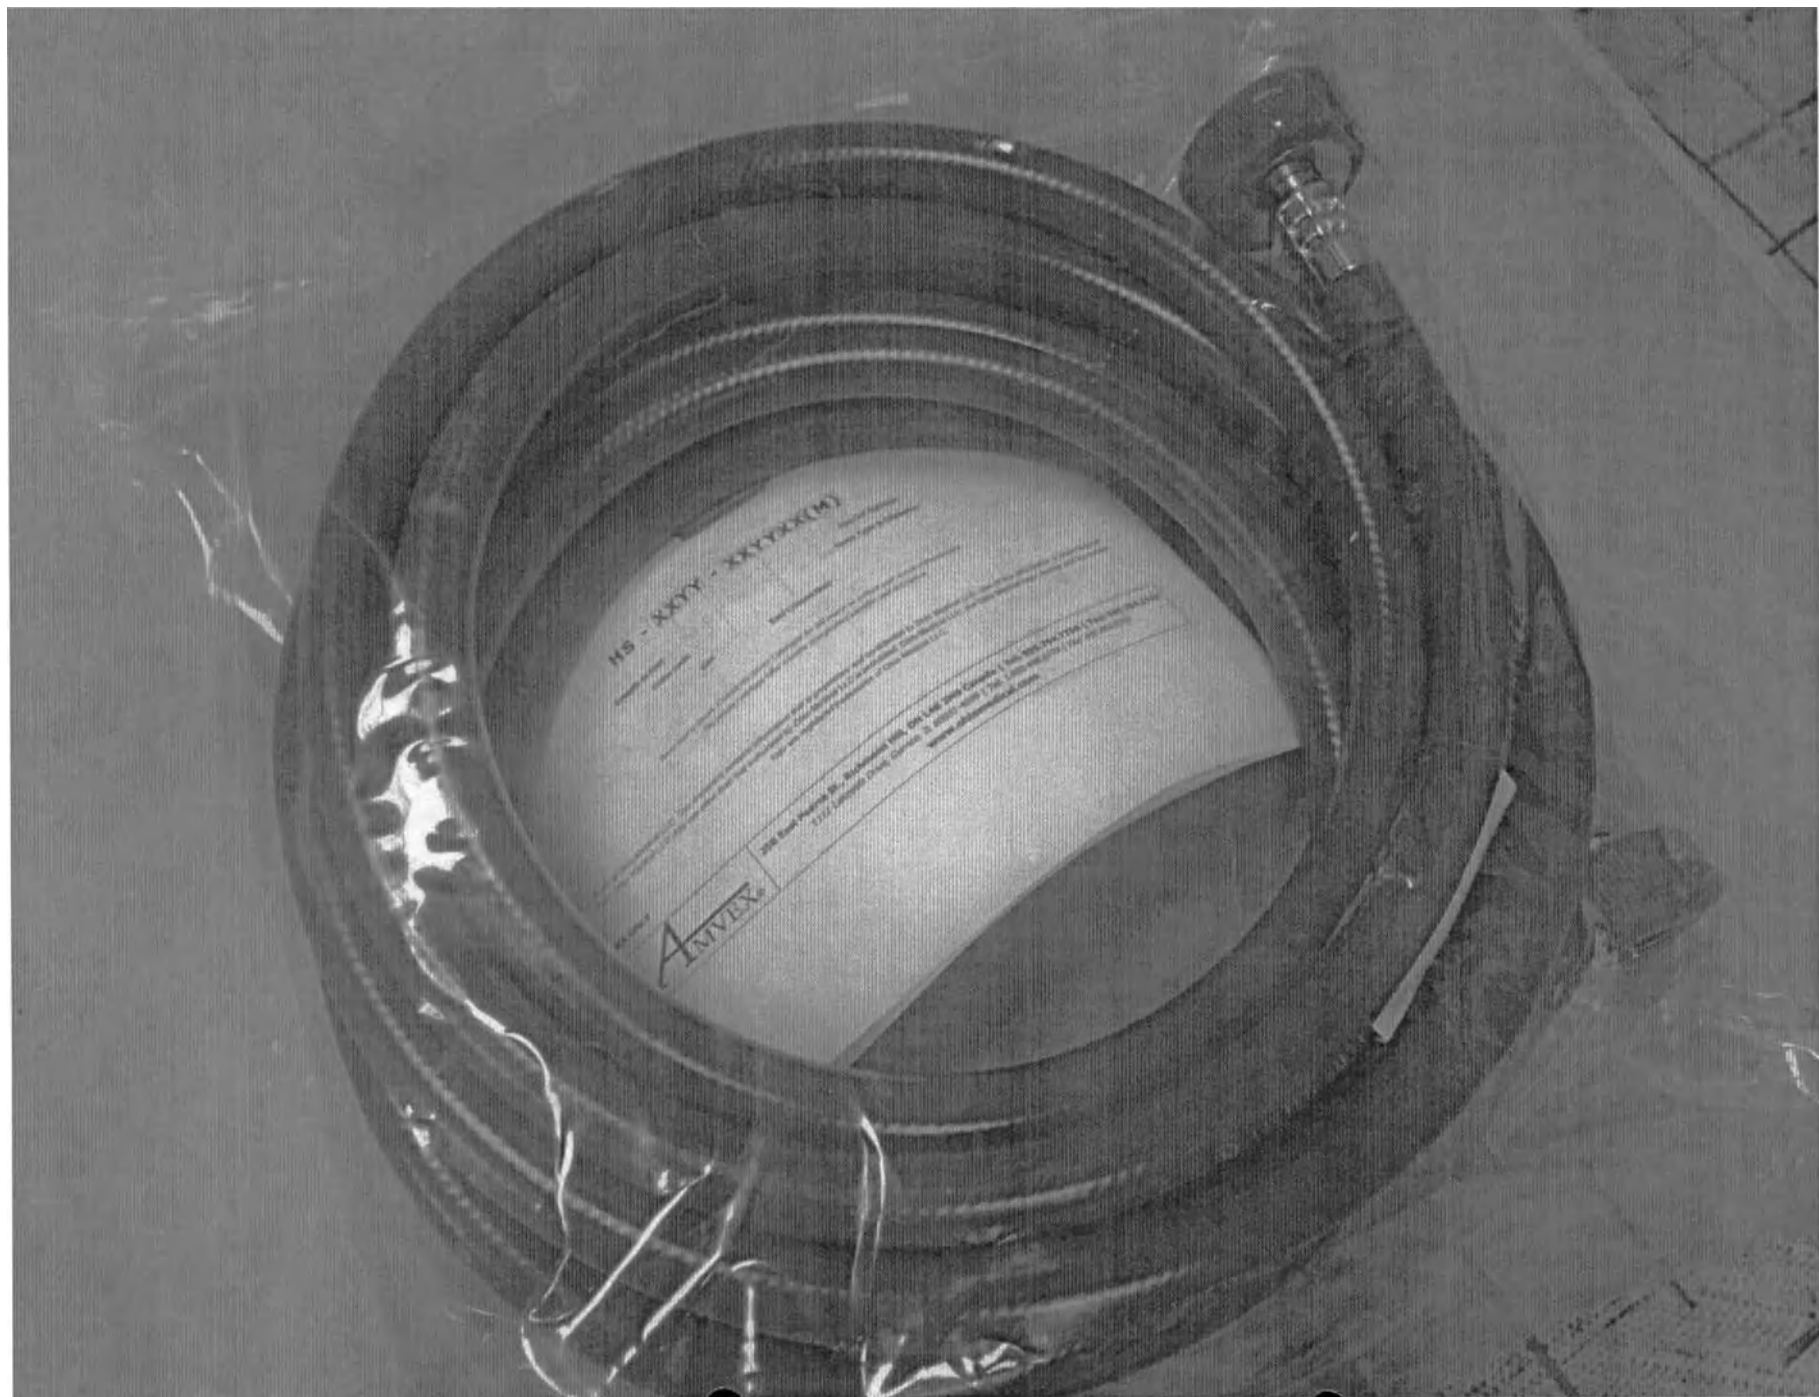

42. Шланги для воздуха с разъемами NIST/DIN, не более 10 шт.

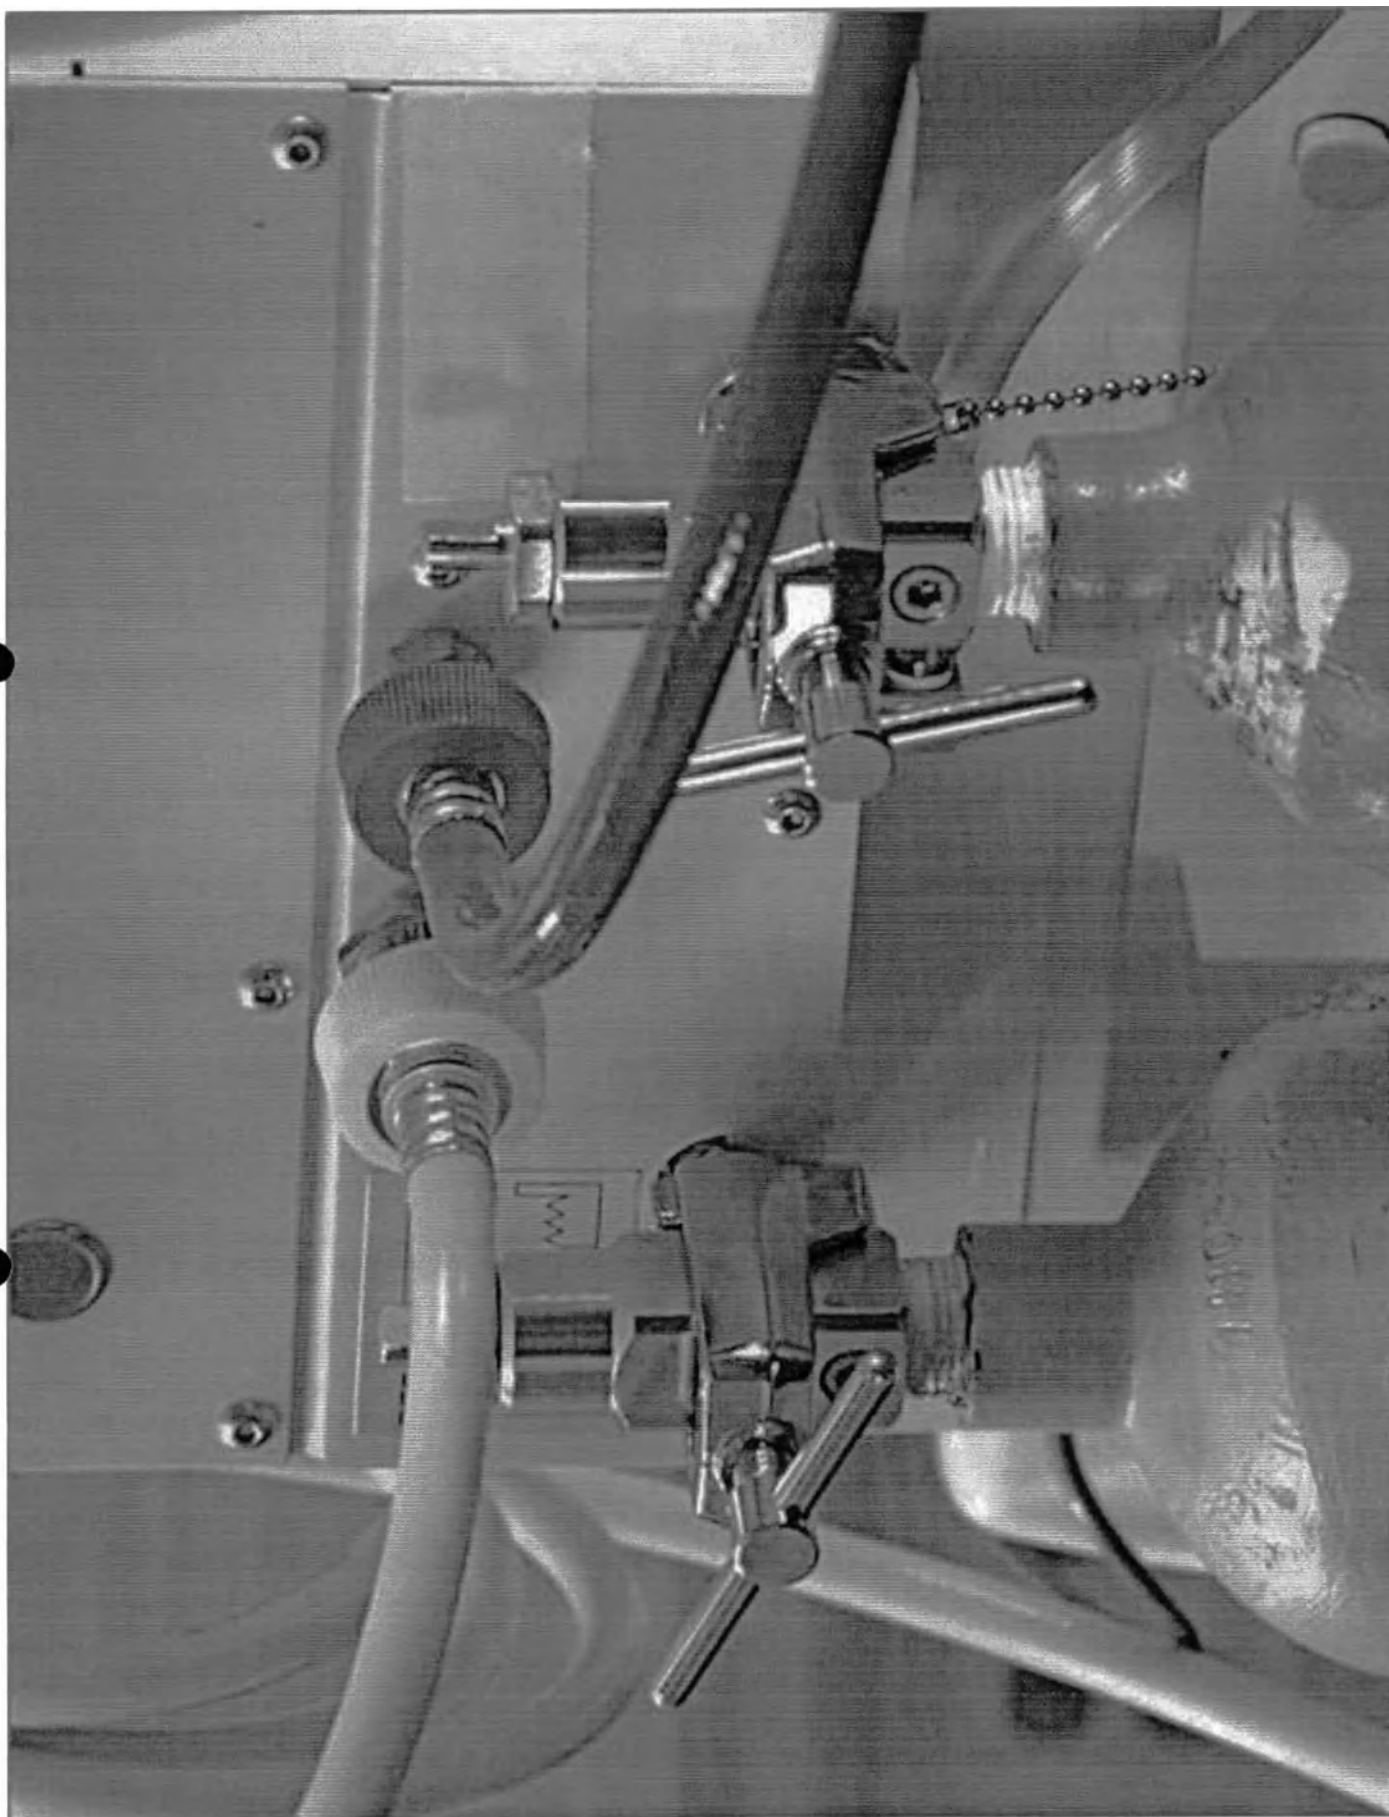




43. Шланги для аспиратора, не более 5 шт.




44. Стойки инфузионные, варианты исполнения:


44.1. Вращающийся штатив для внутривенных вливаний (не более 5 шт) (при необходимости),

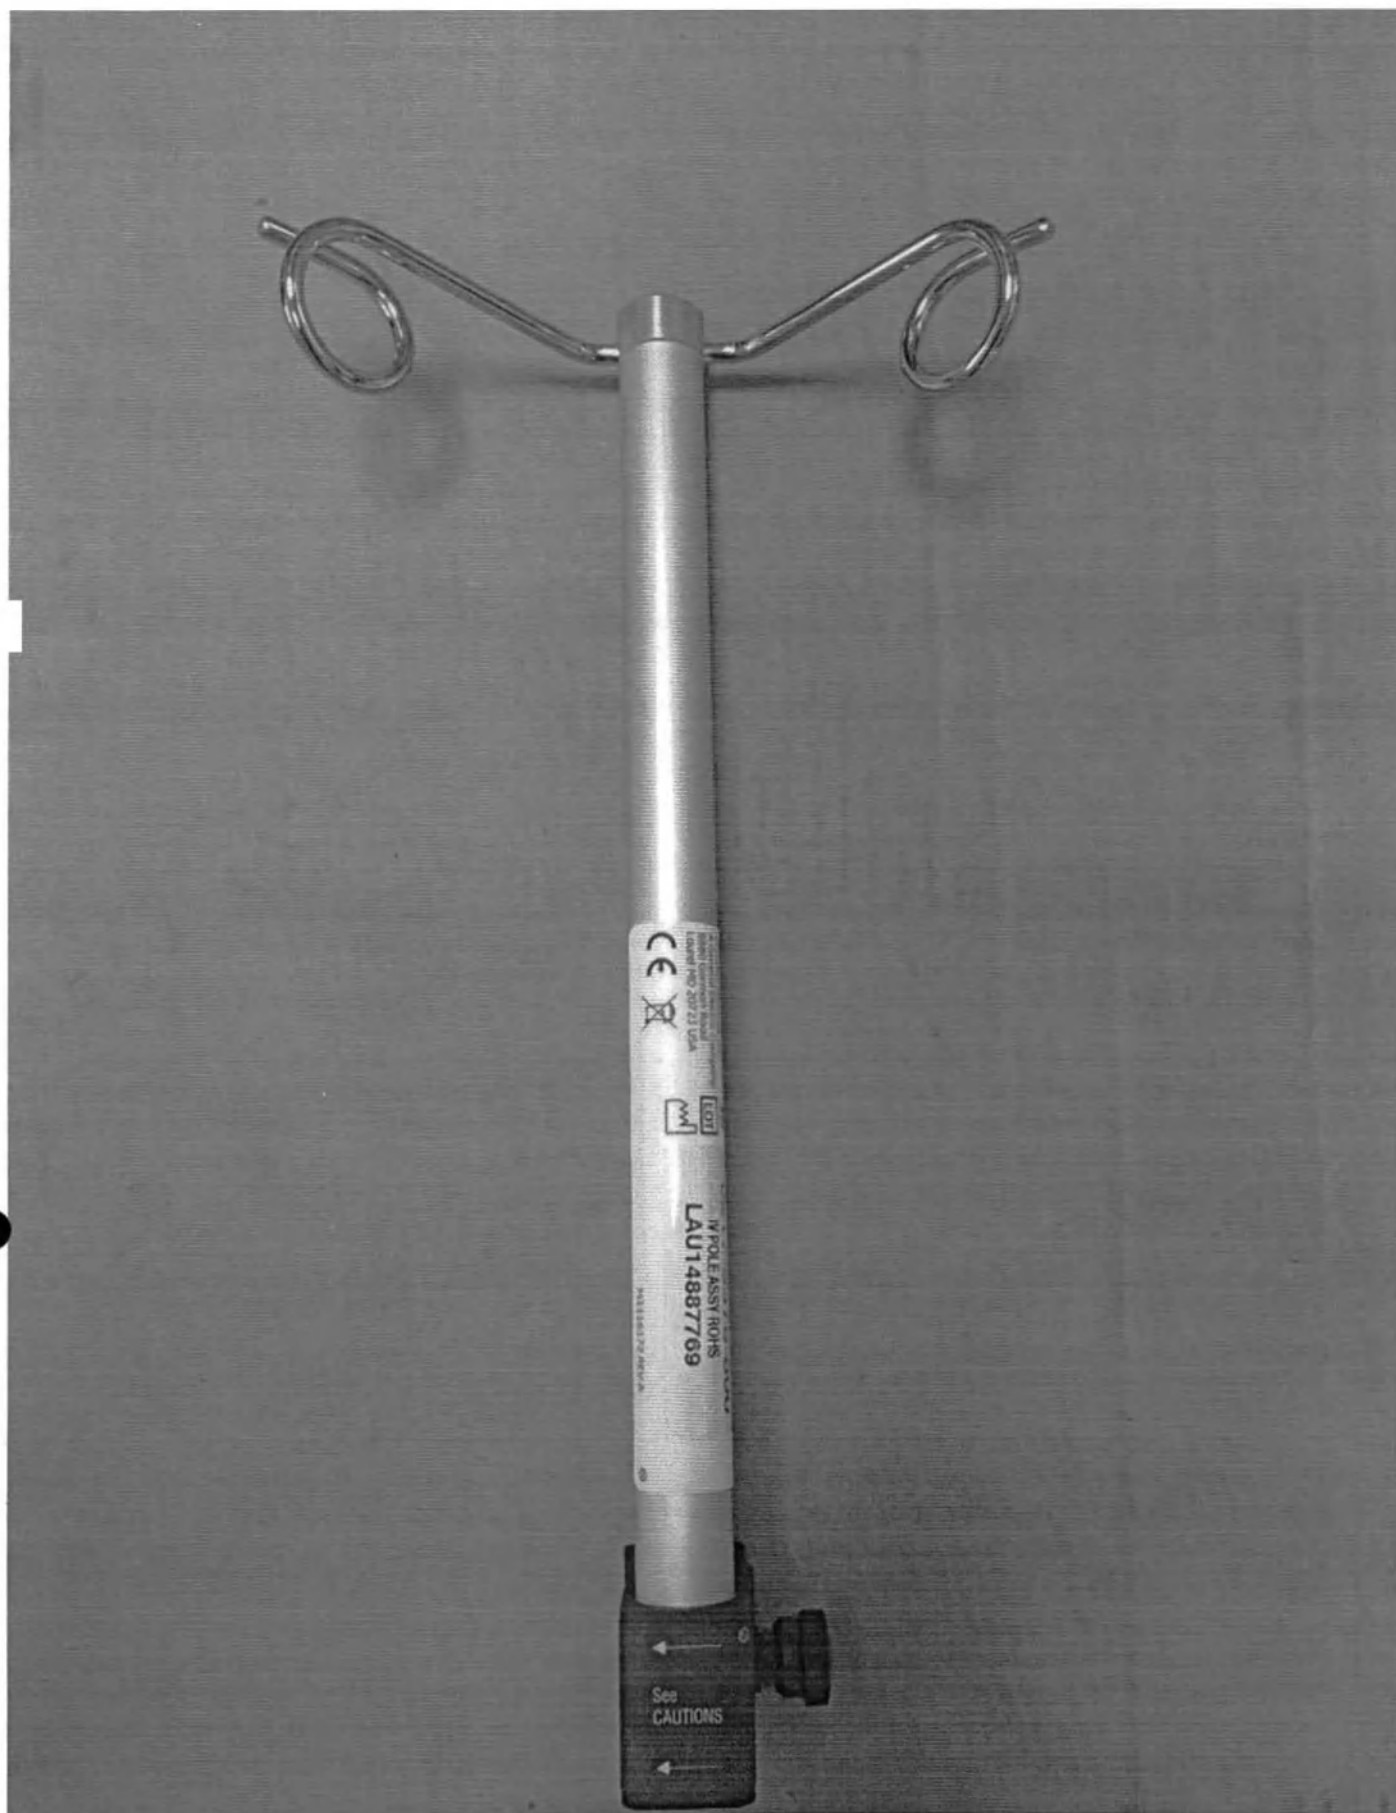


44.2. Штатив для внутривенных вливаний в сборе

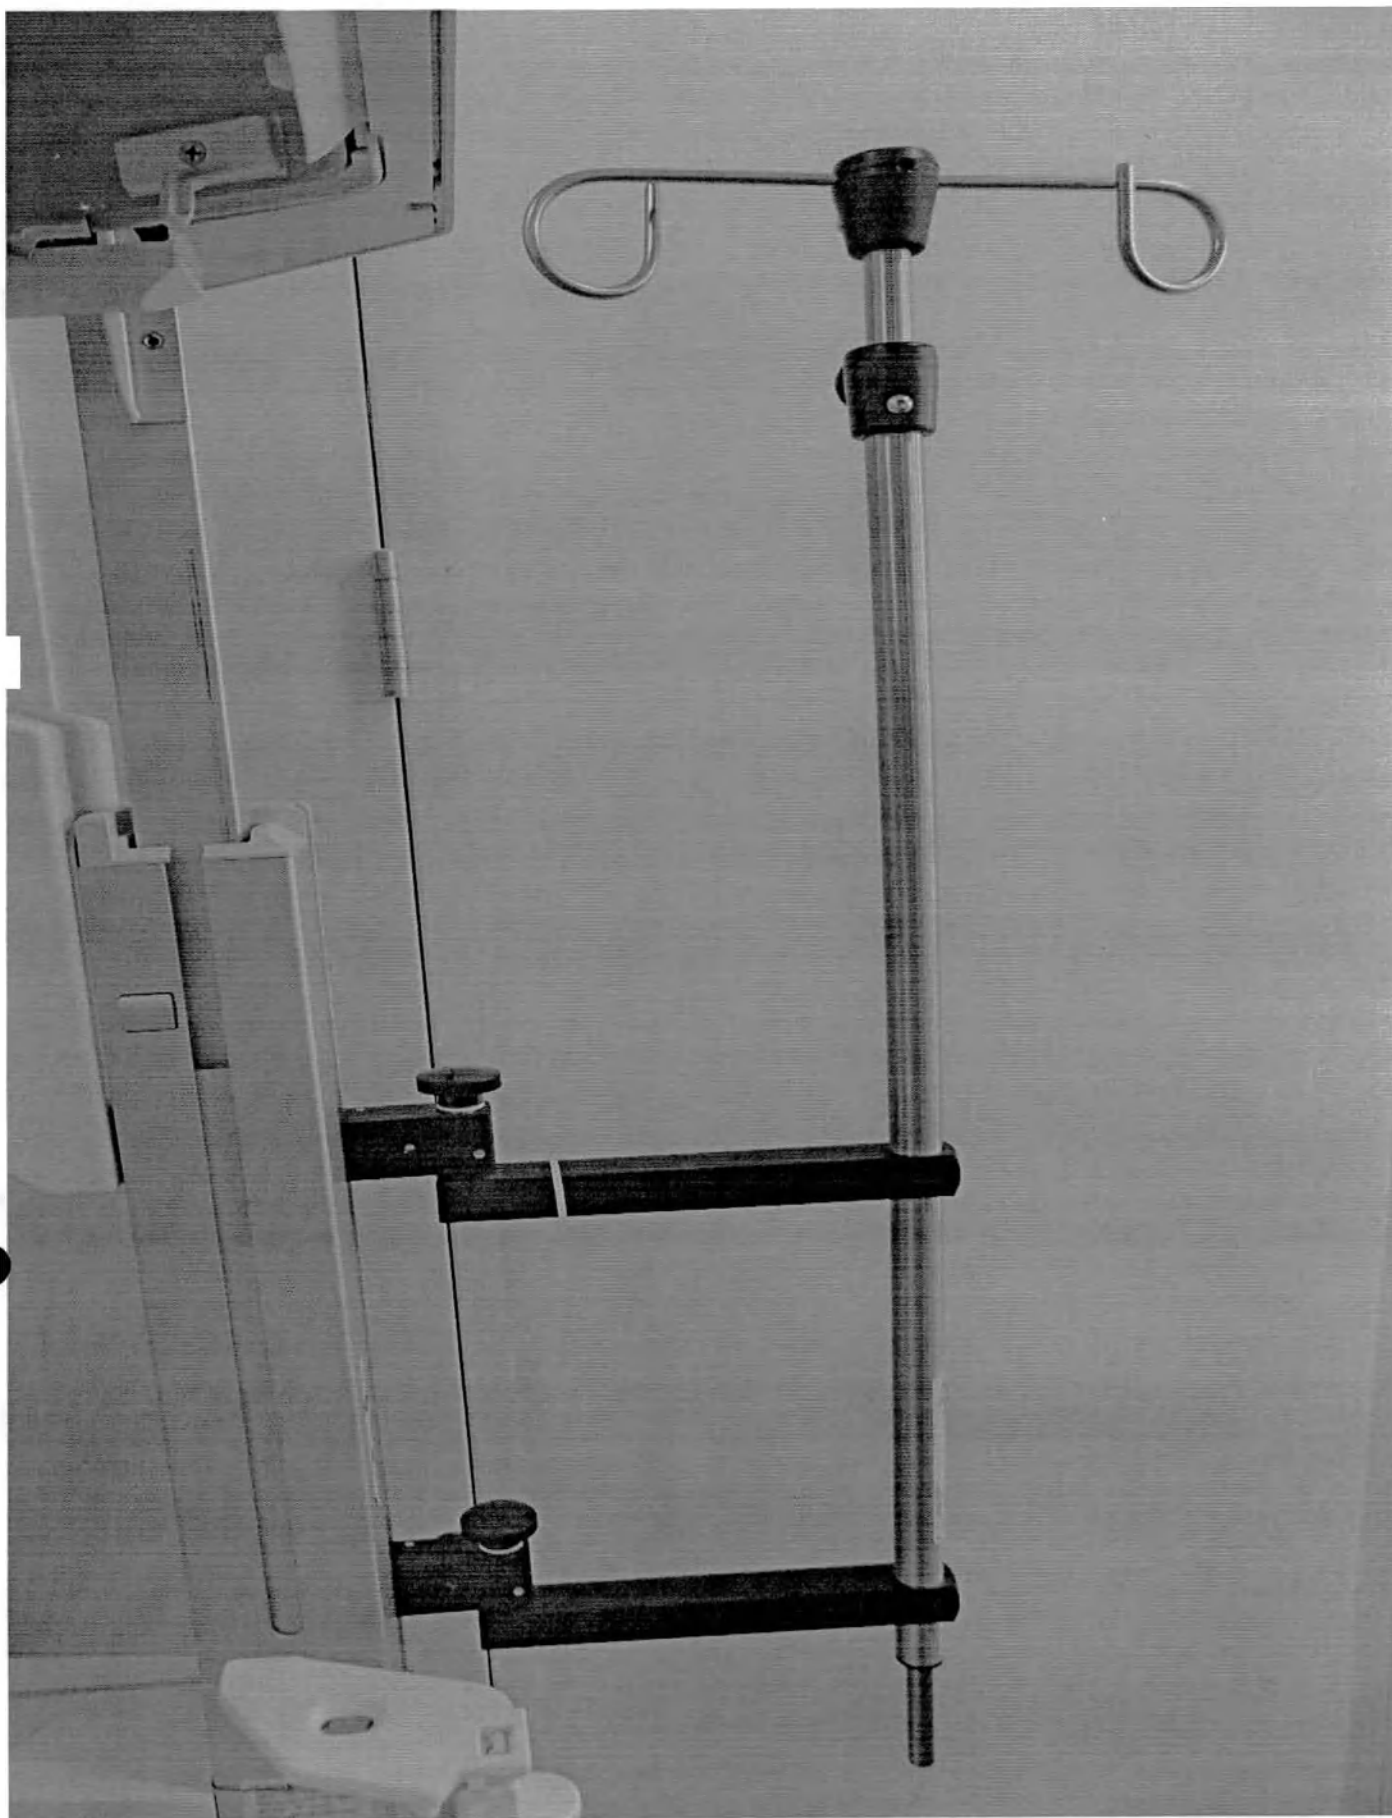


45. Крепежи, не более 5 шт.

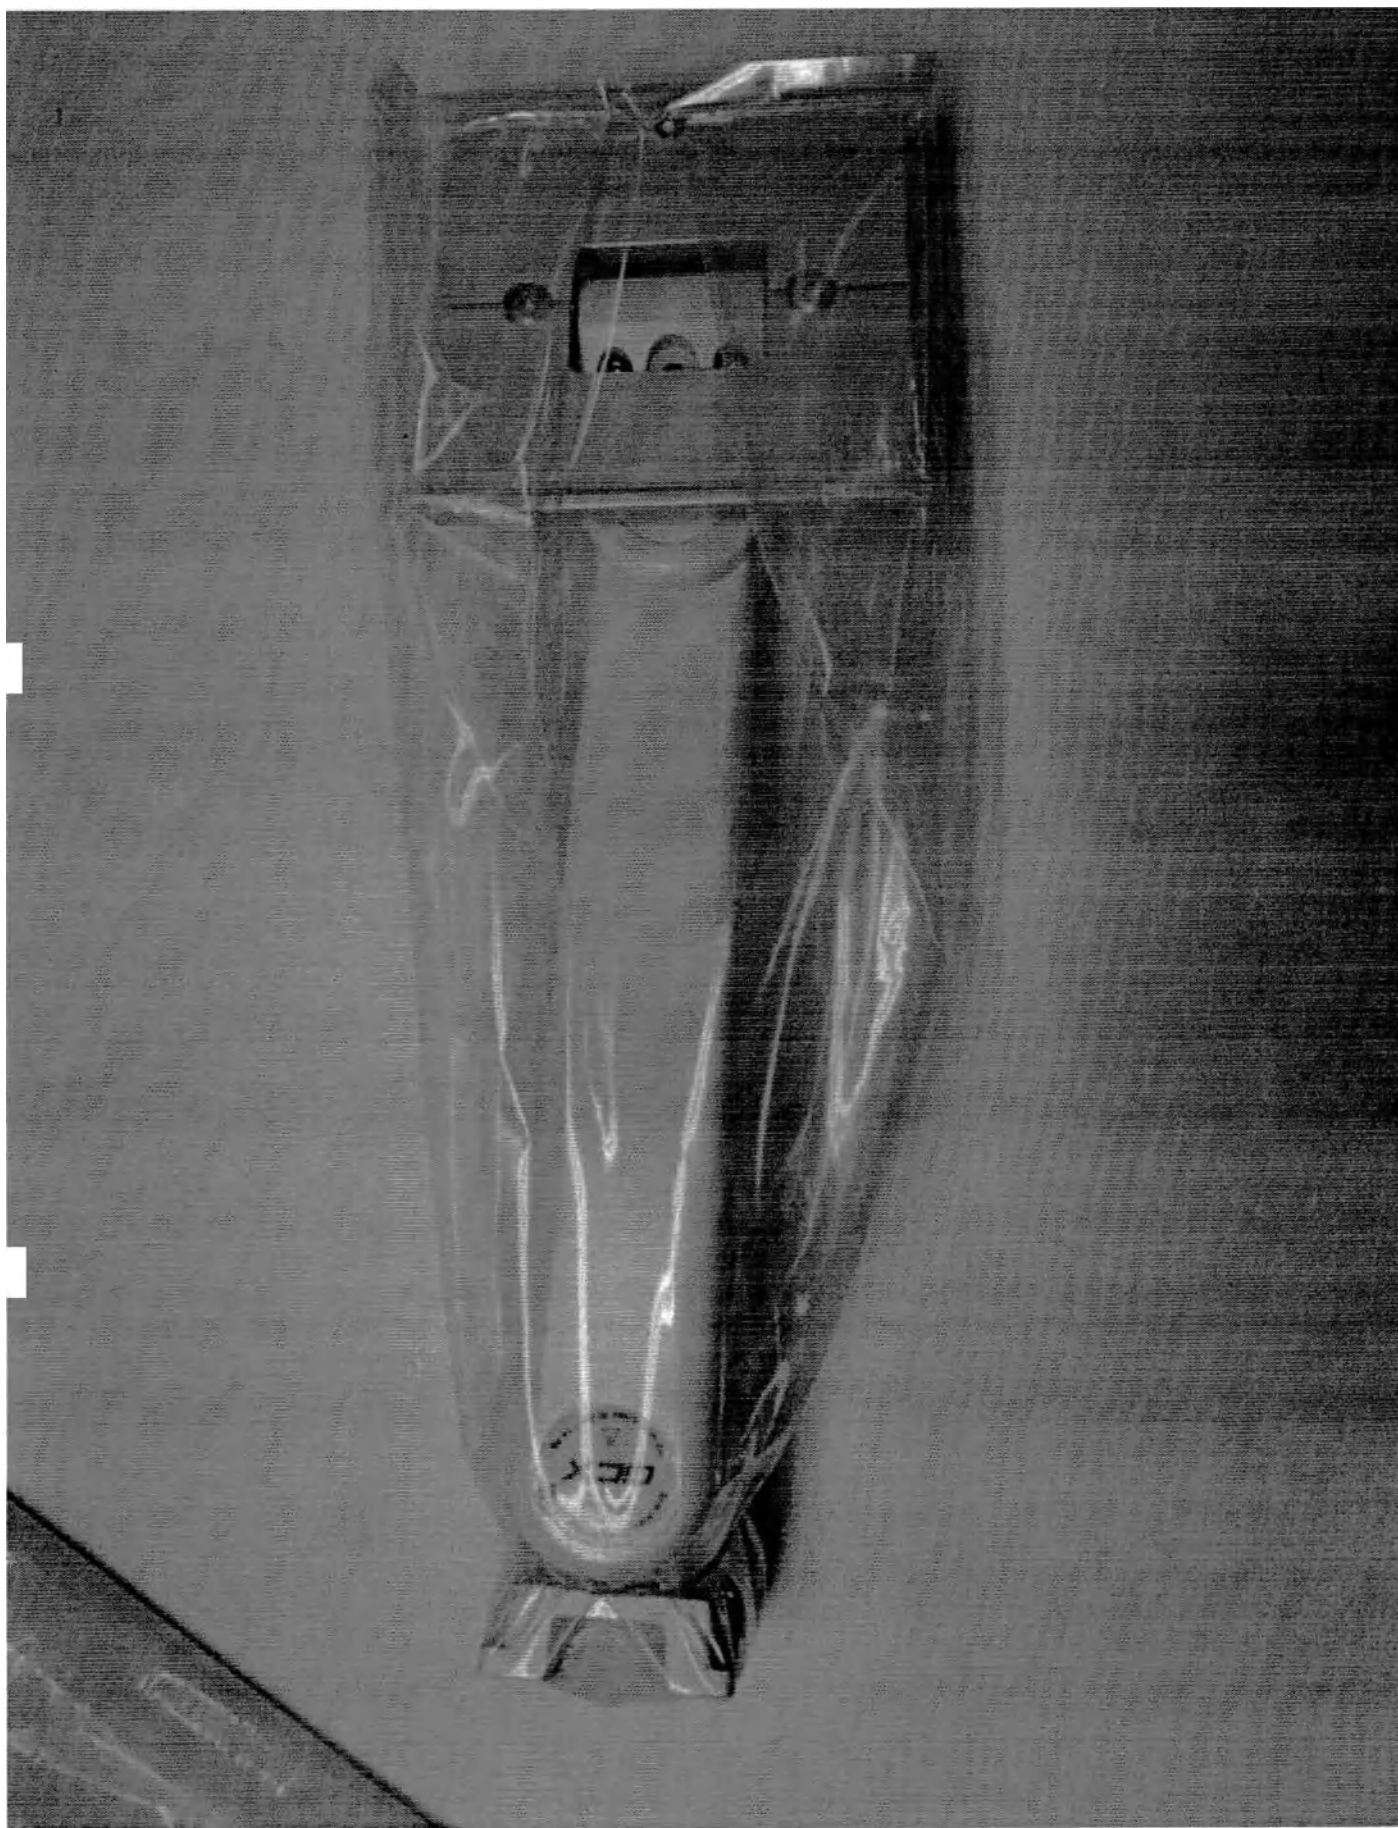


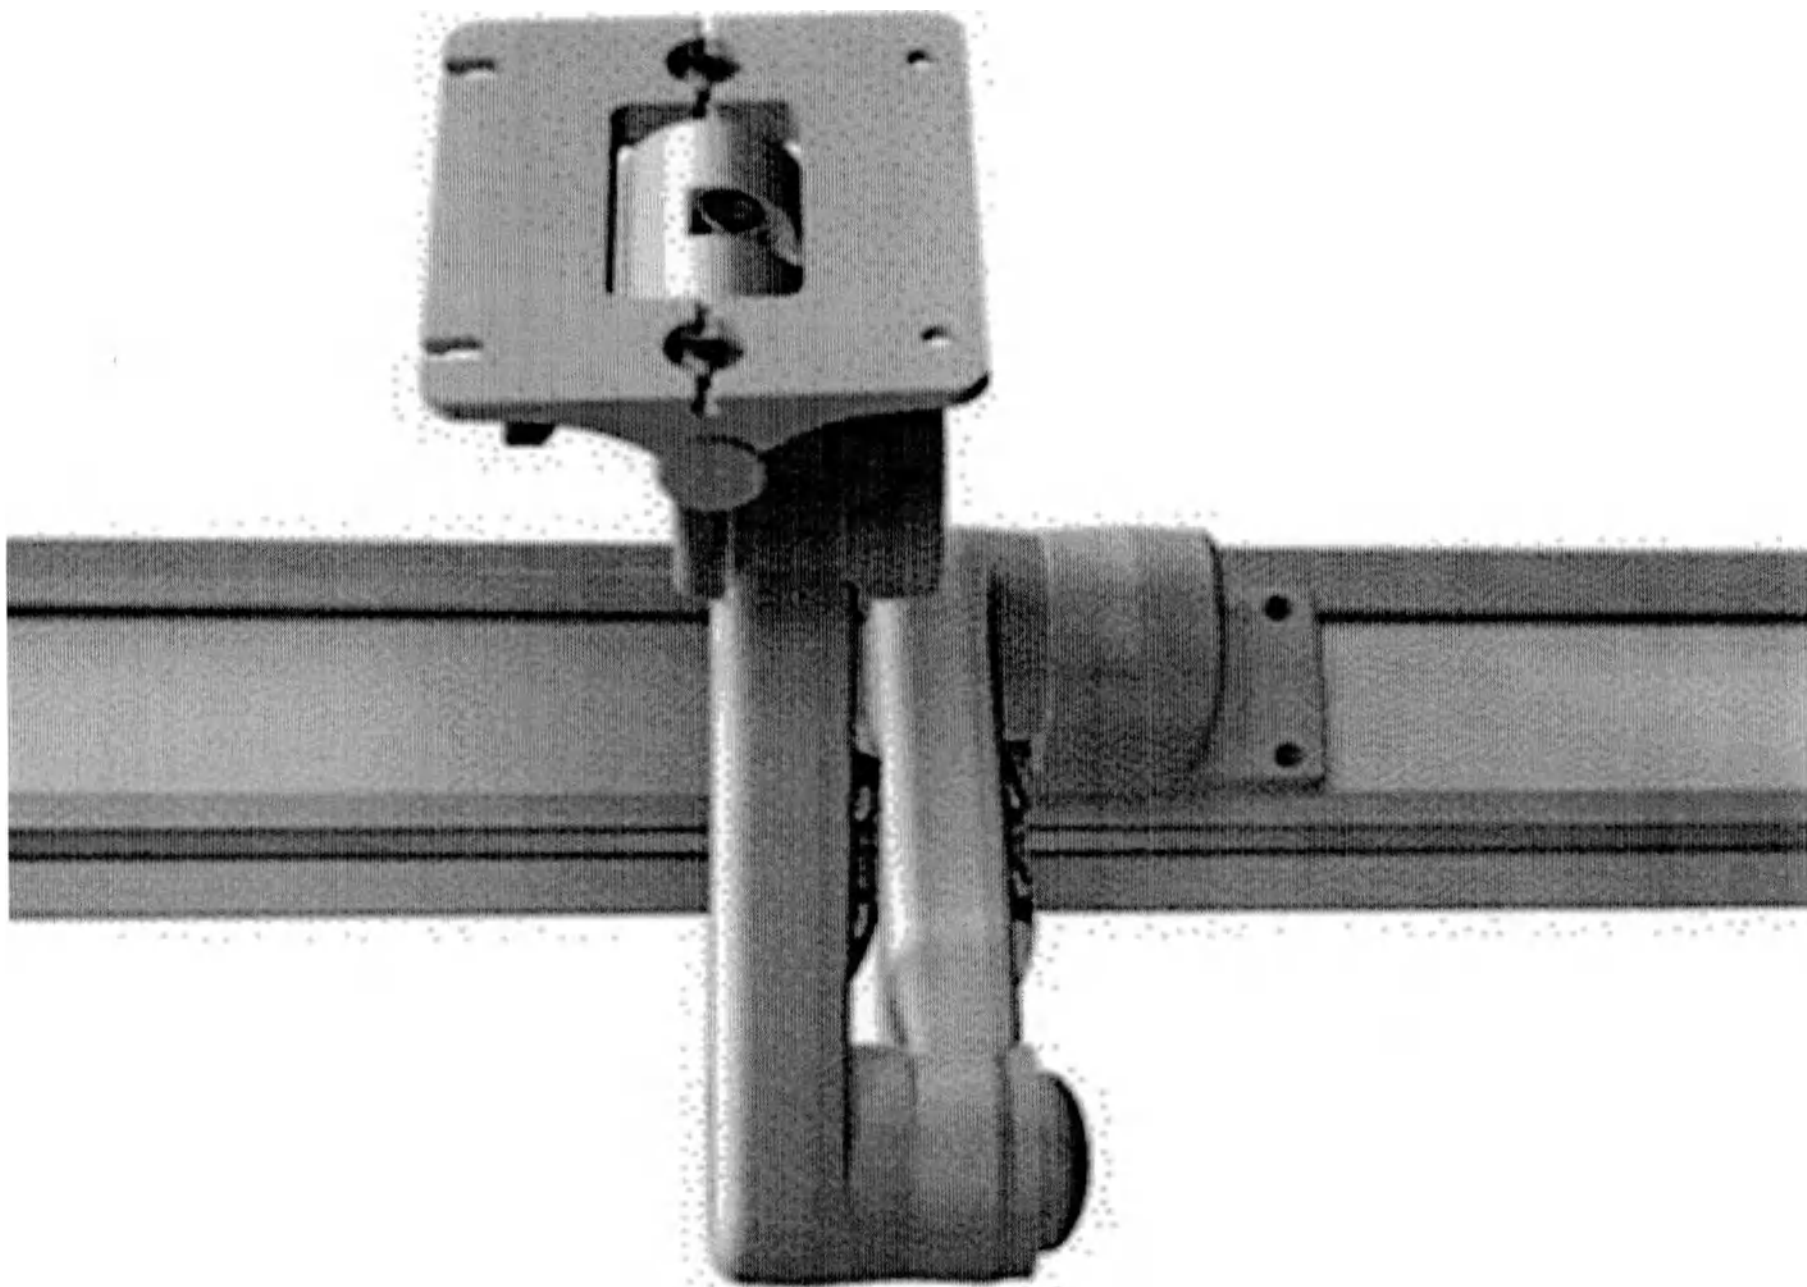


46. Крепежи для монитора пациента, варианты исполнения:
46.1. Крепеж для монитора с задним каналом, не более 5 шт.

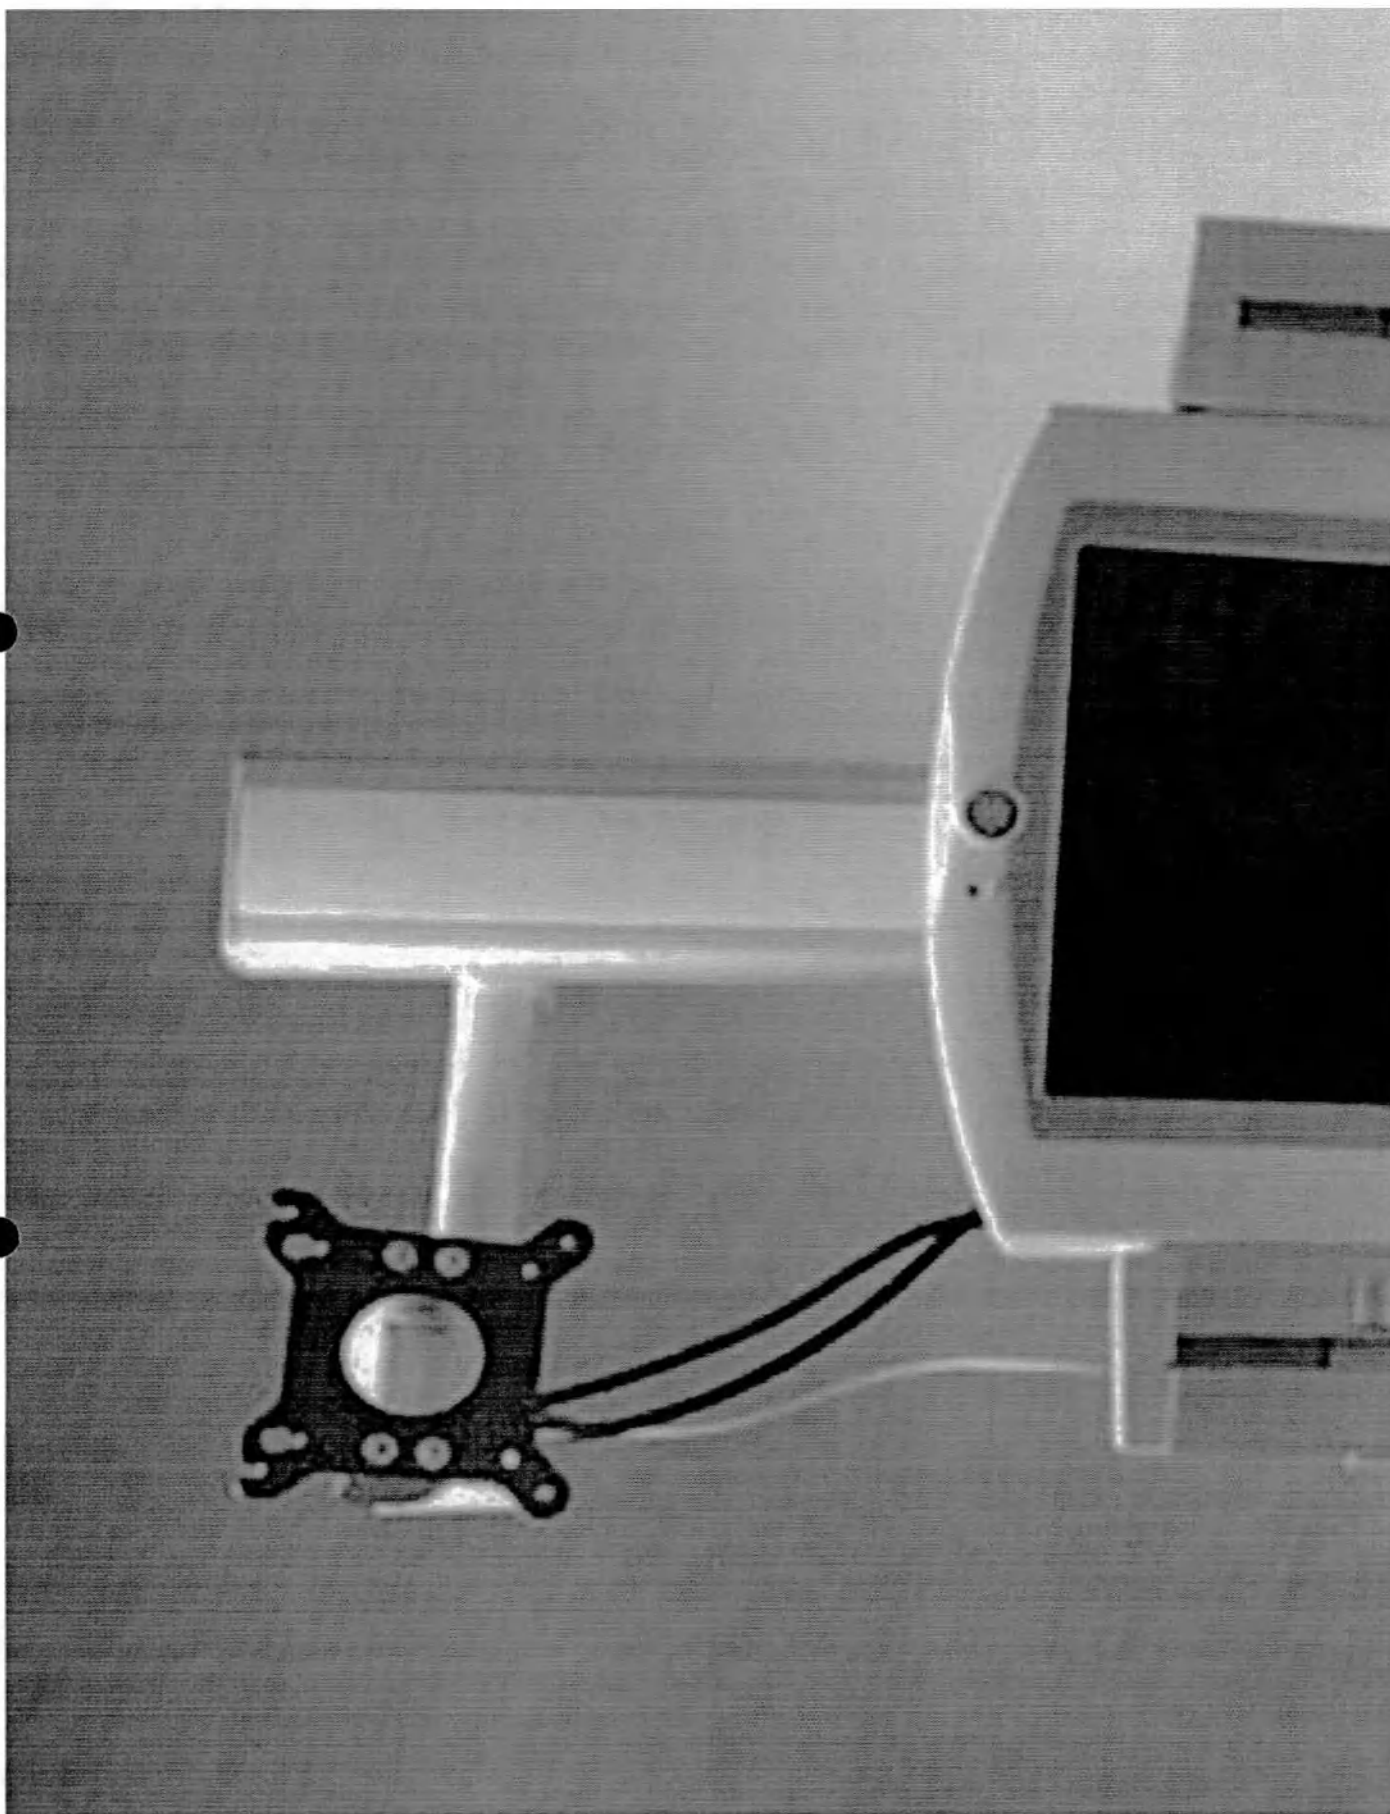


46.2. Крепеж для монитора пациента с левым и правым каналом, не более 5 шт.

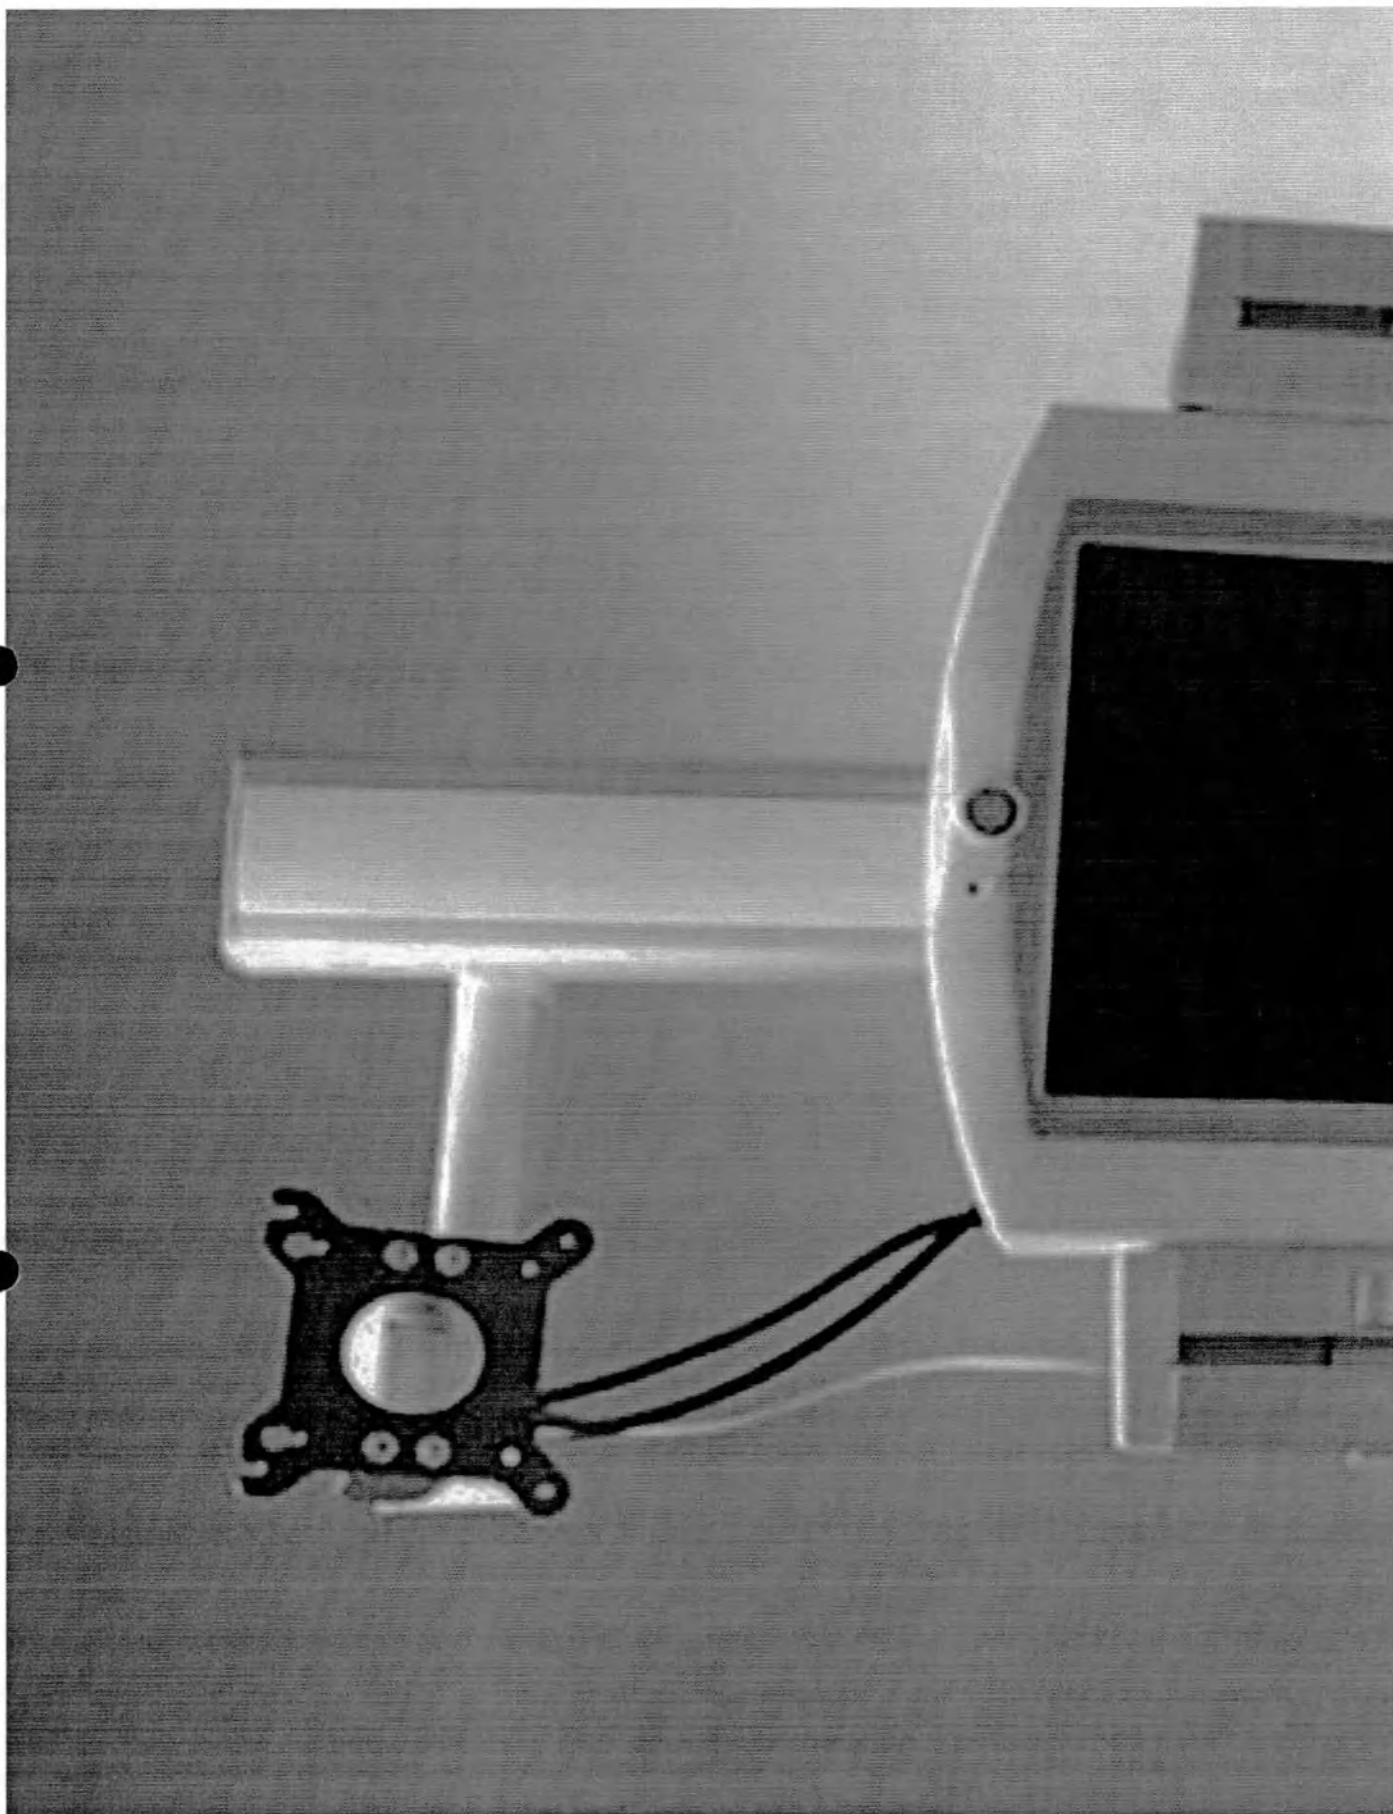


47. Держатели для крепления мешка и маски, не более 10 шт.

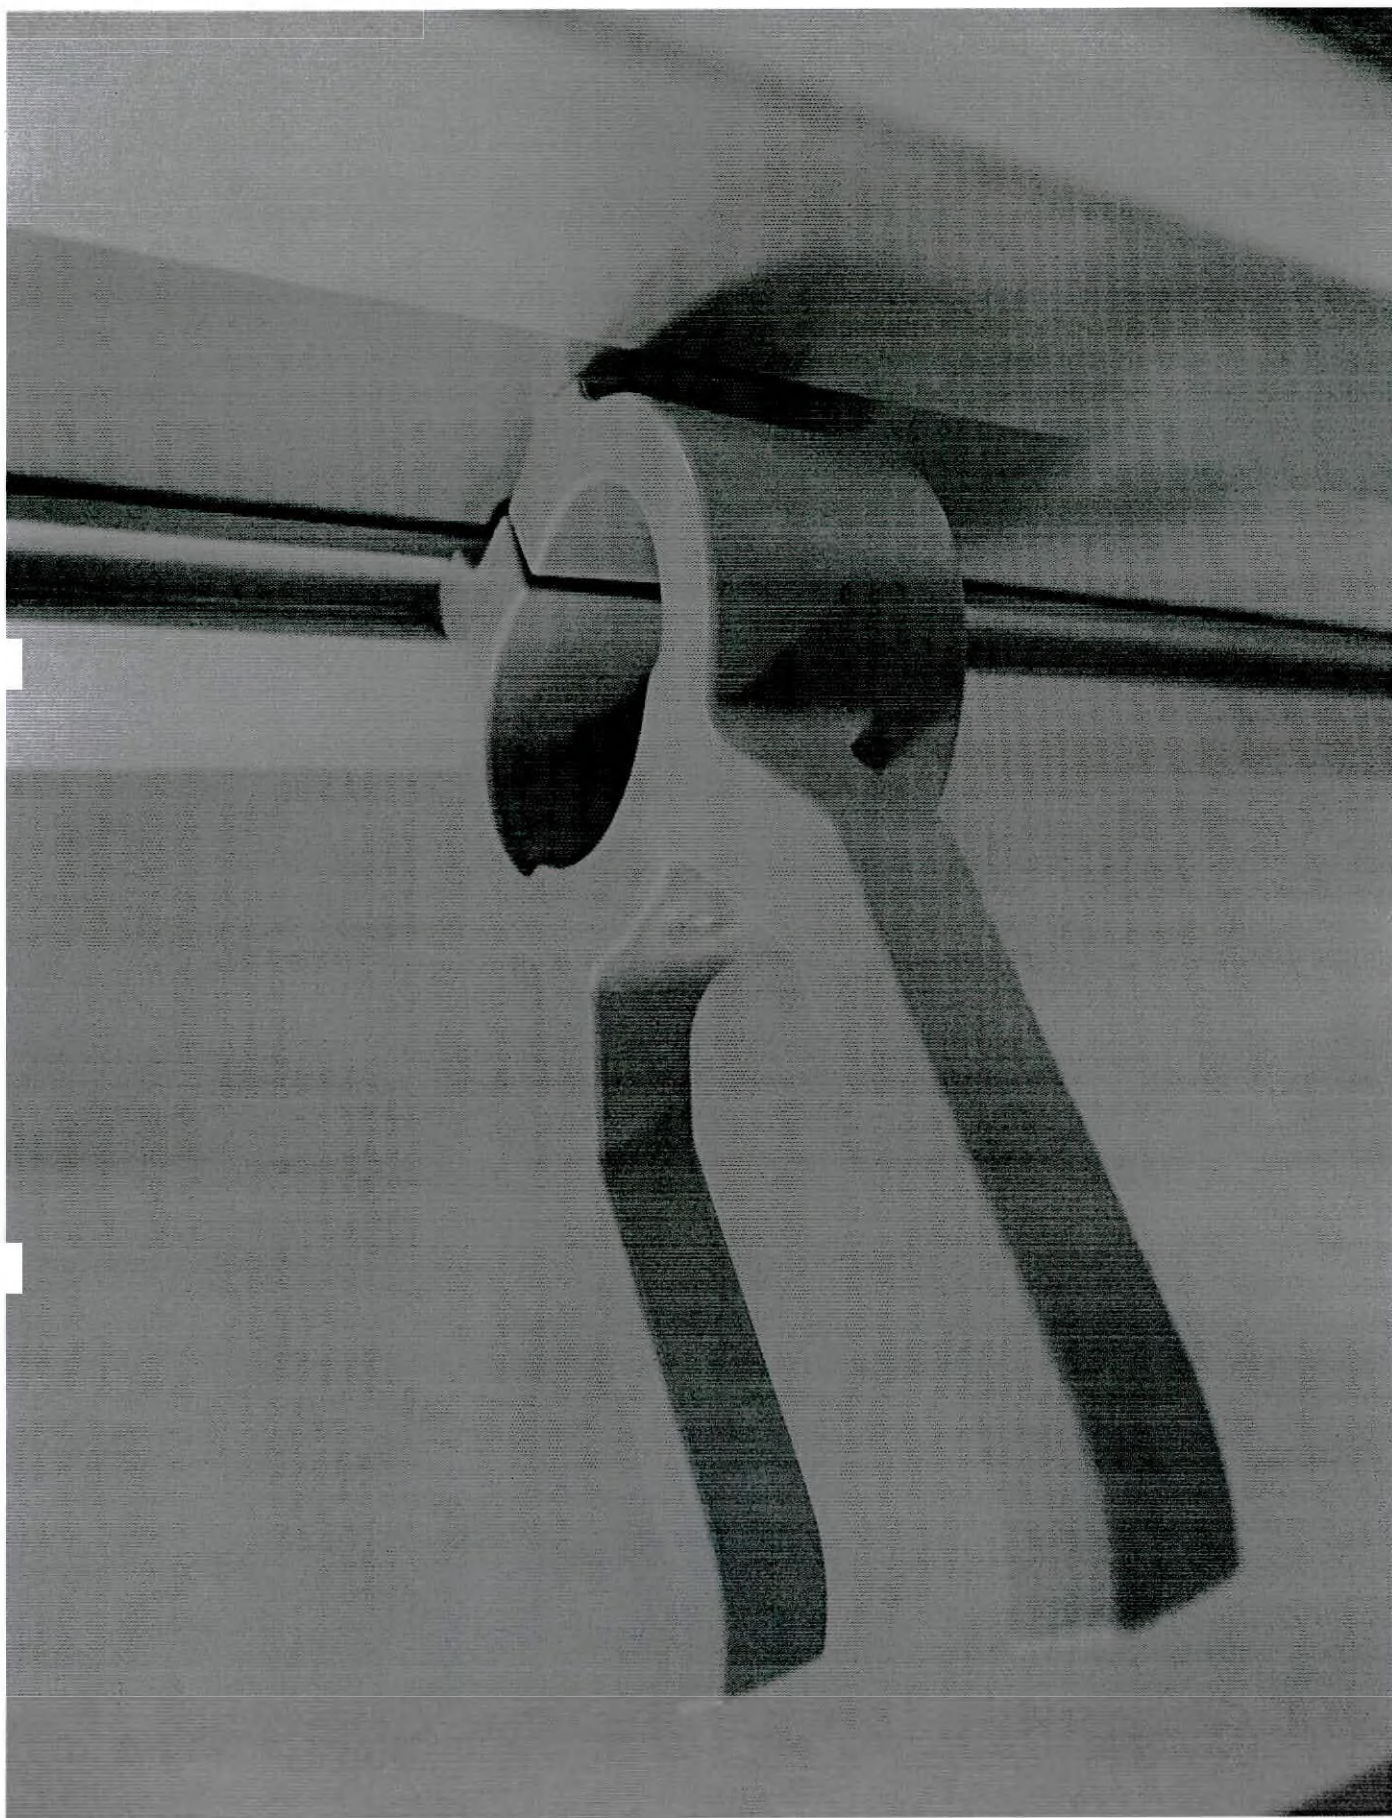


48. Крепежи для направления трубок, не более 10 шт.

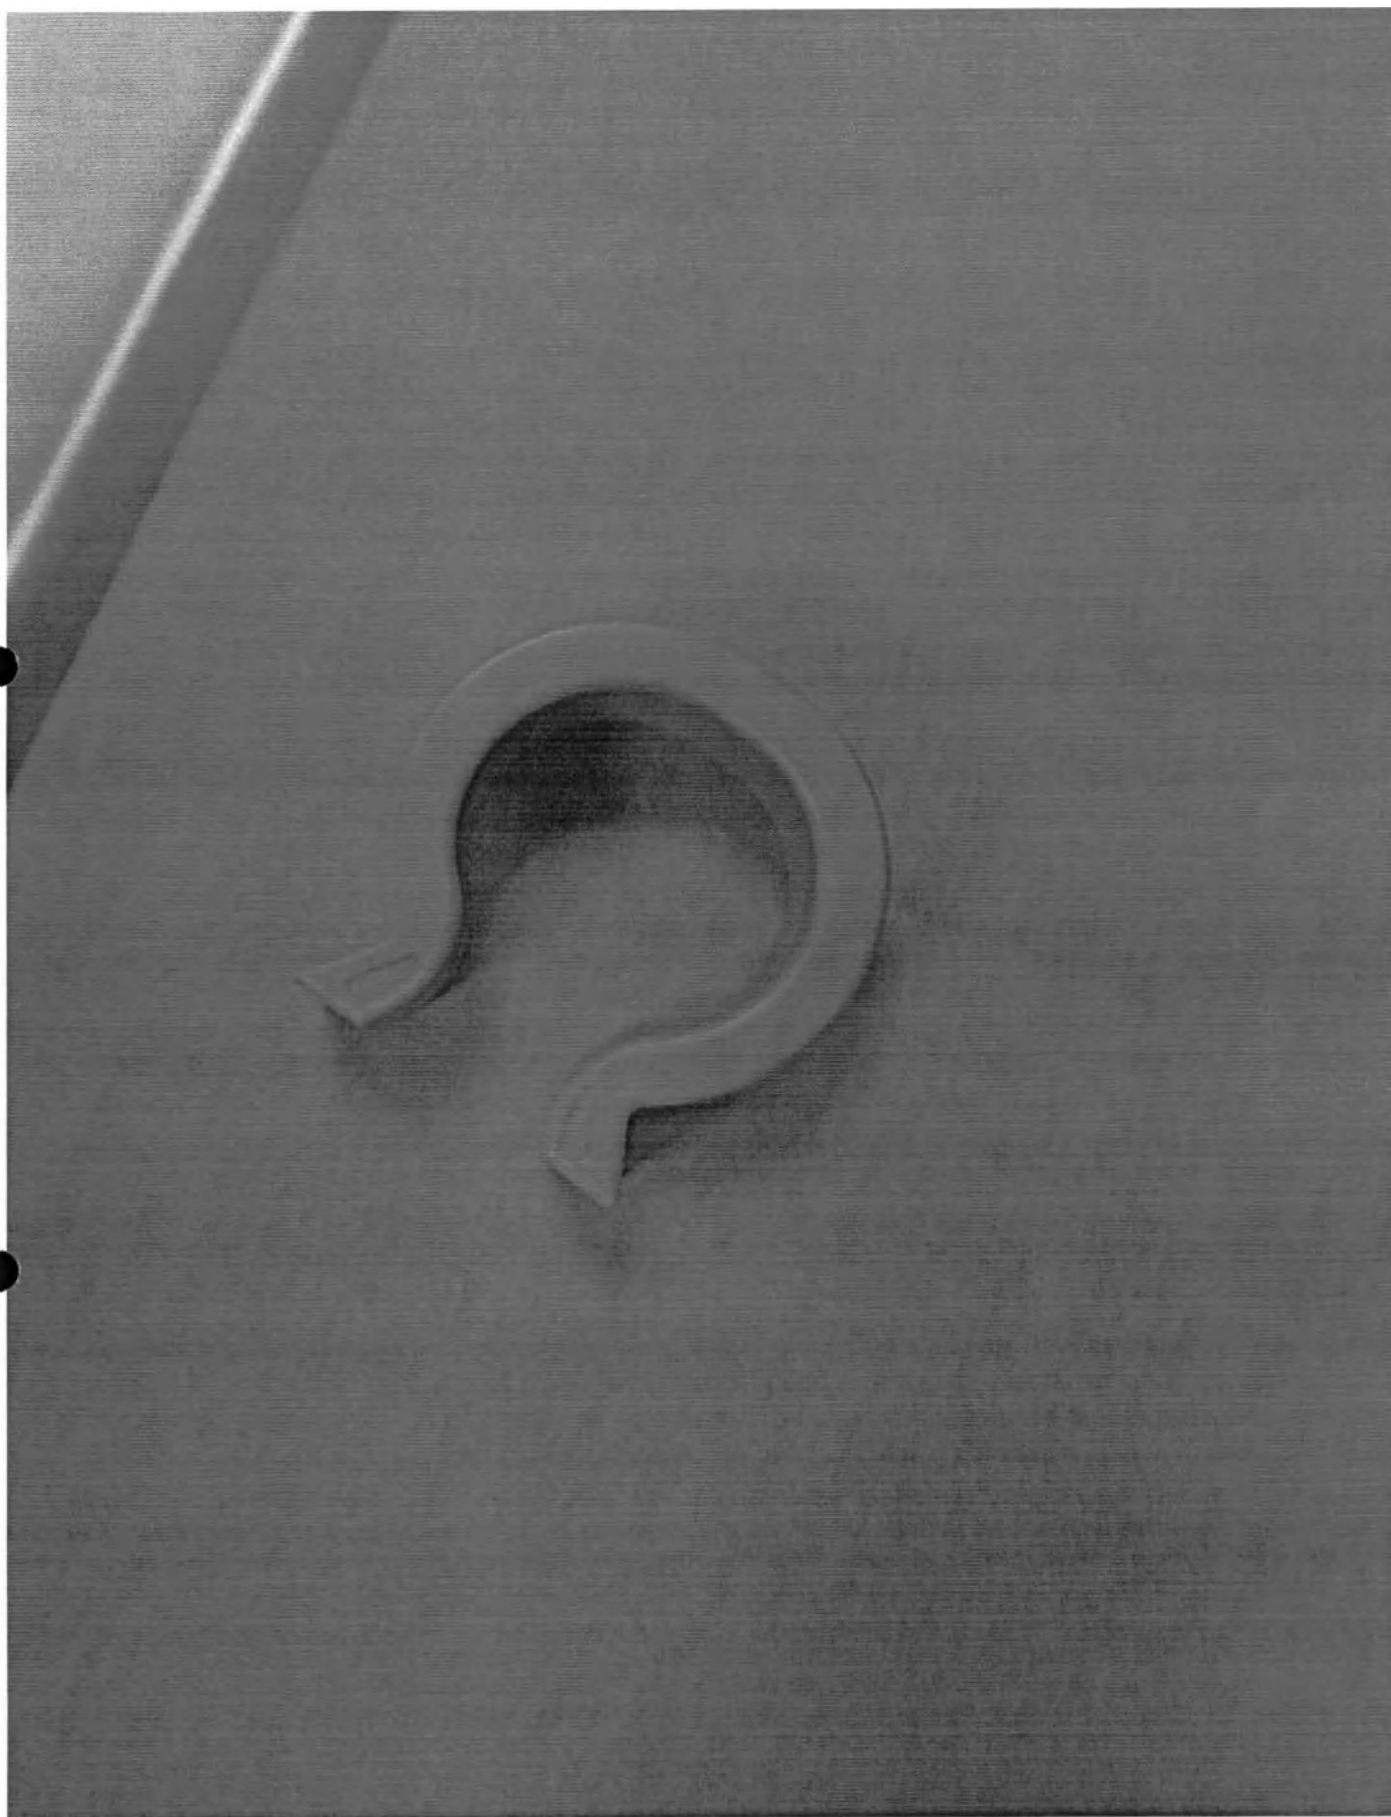


49. Крепежи для газовых баллонов малого размера и/или среднего и/или большого, не более 5 шт.

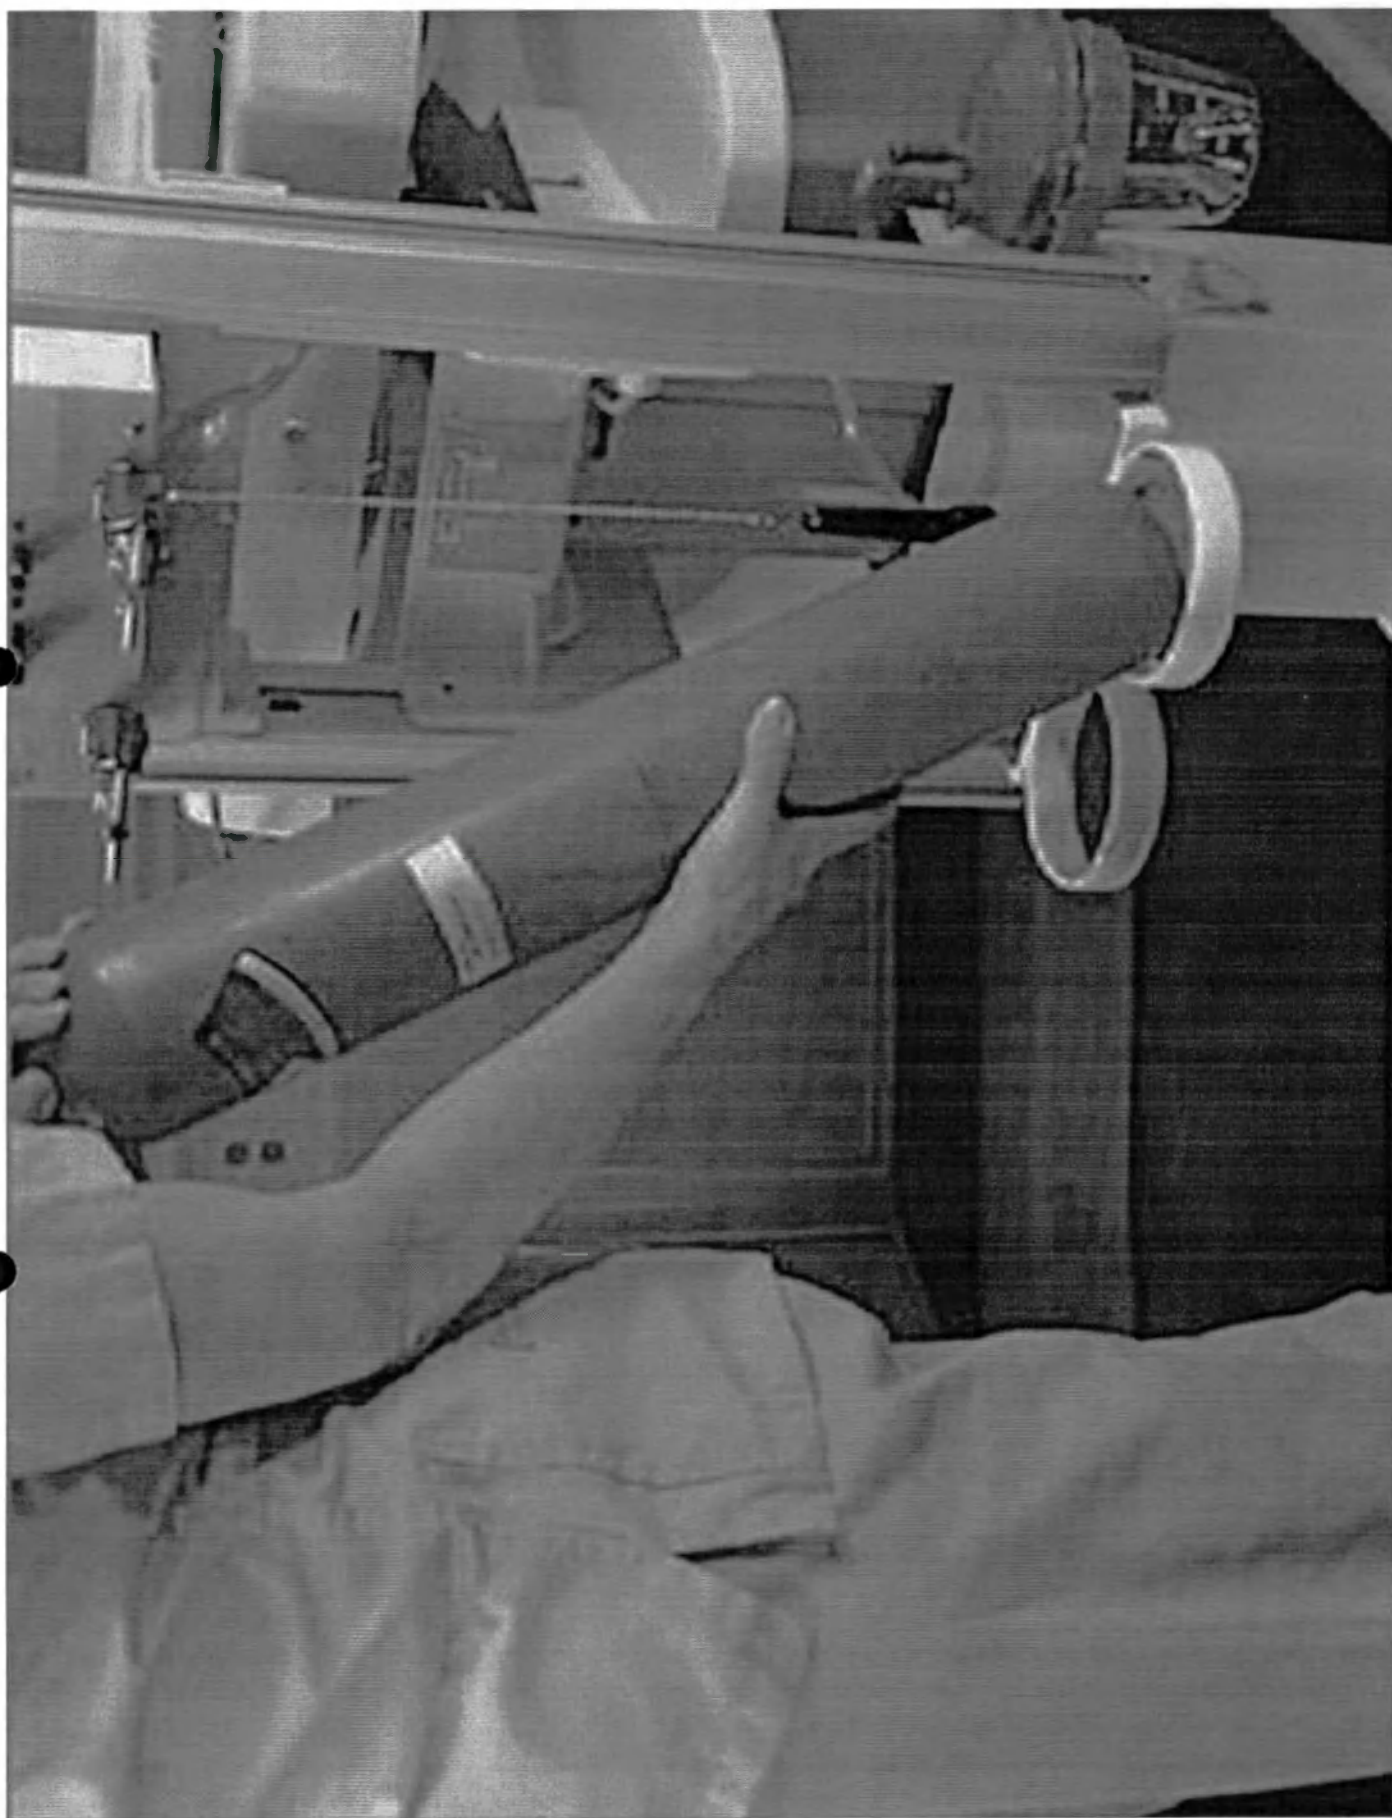


50. Крепежи для установки дополнительных приборов, не более 10 шт.

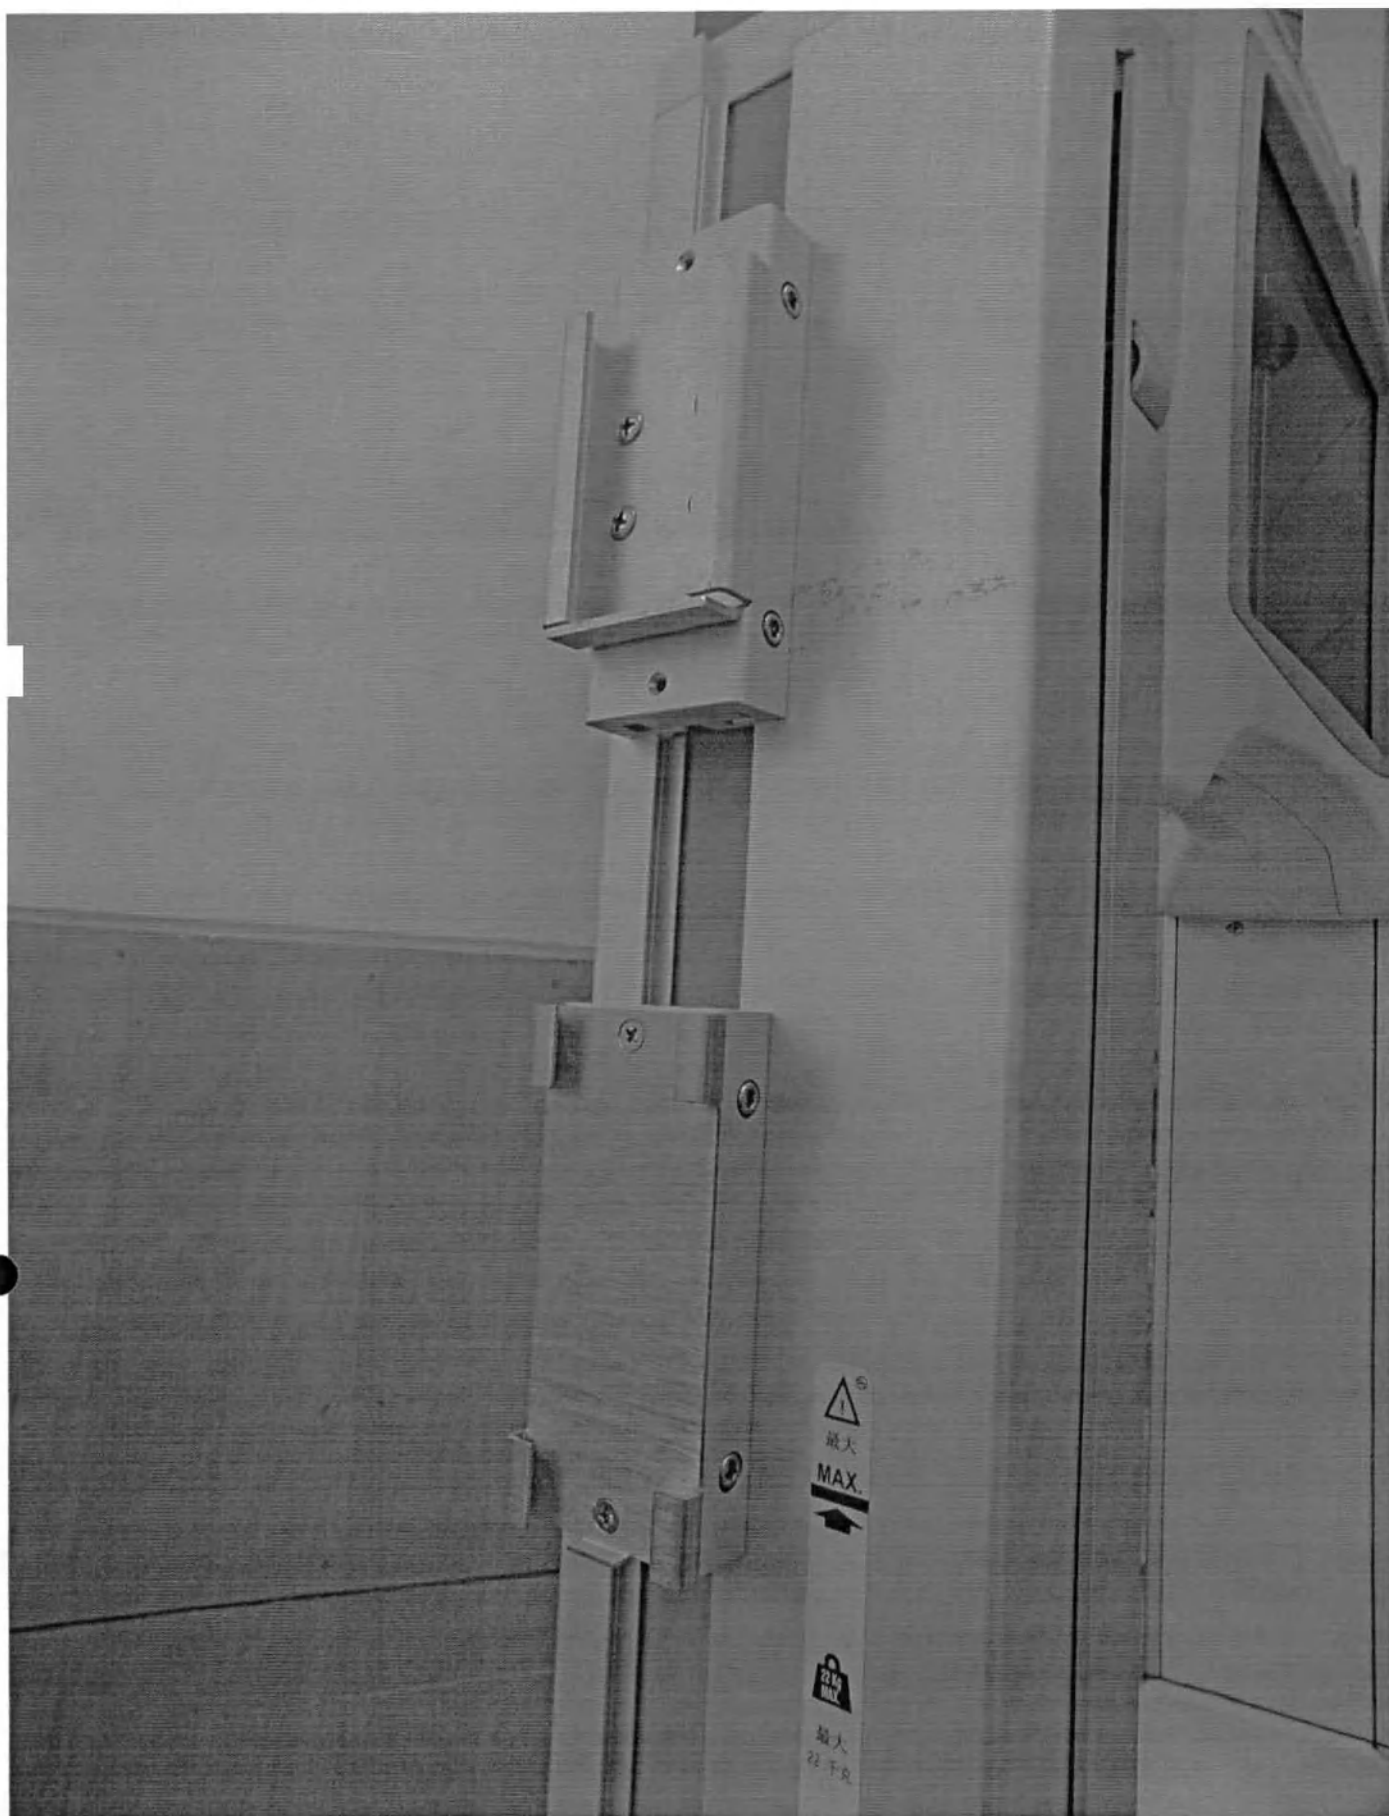


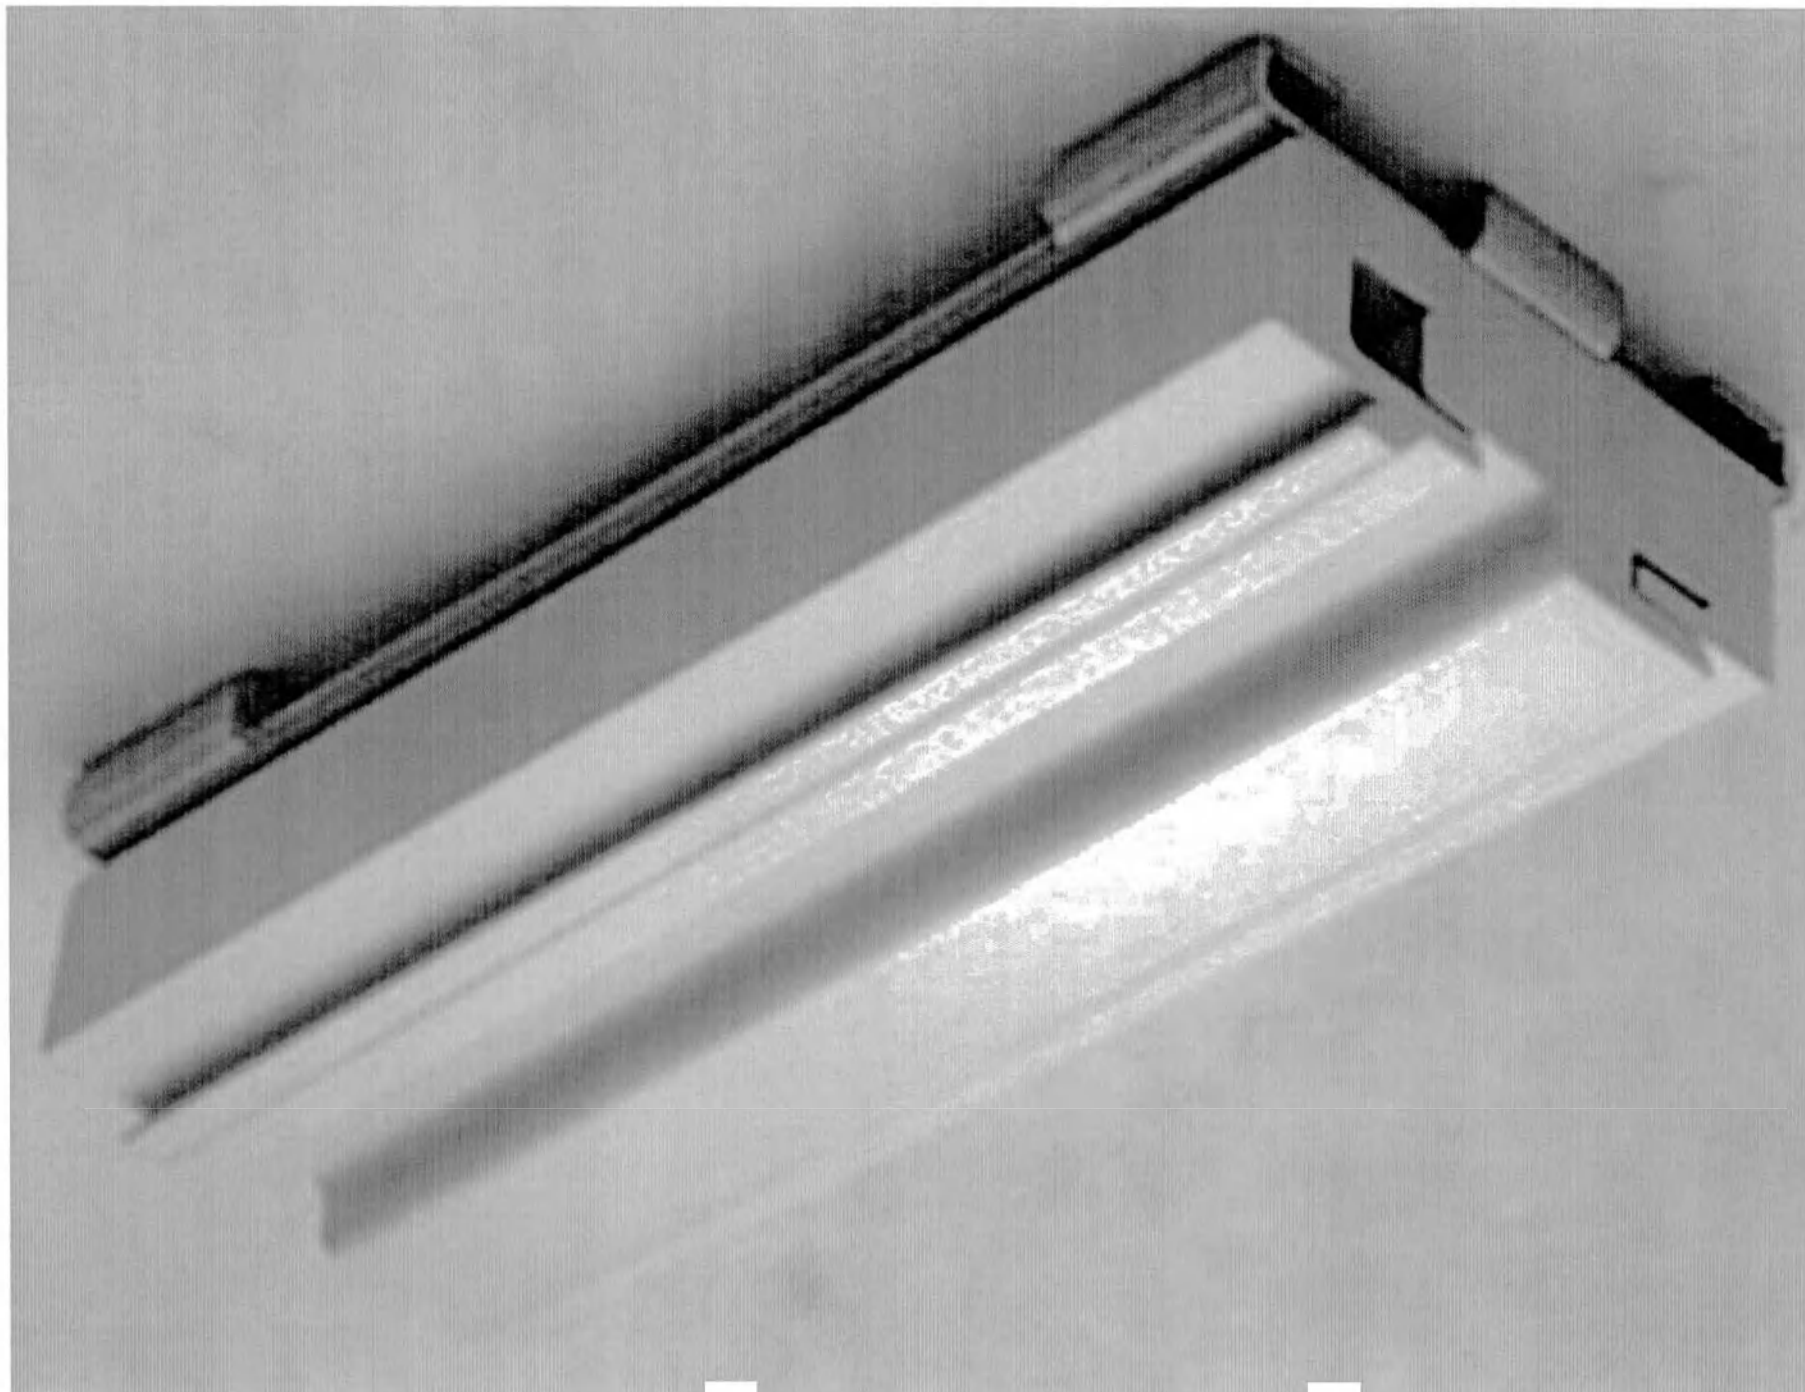

51. Уплотнители для окошек, не более 20 шт.

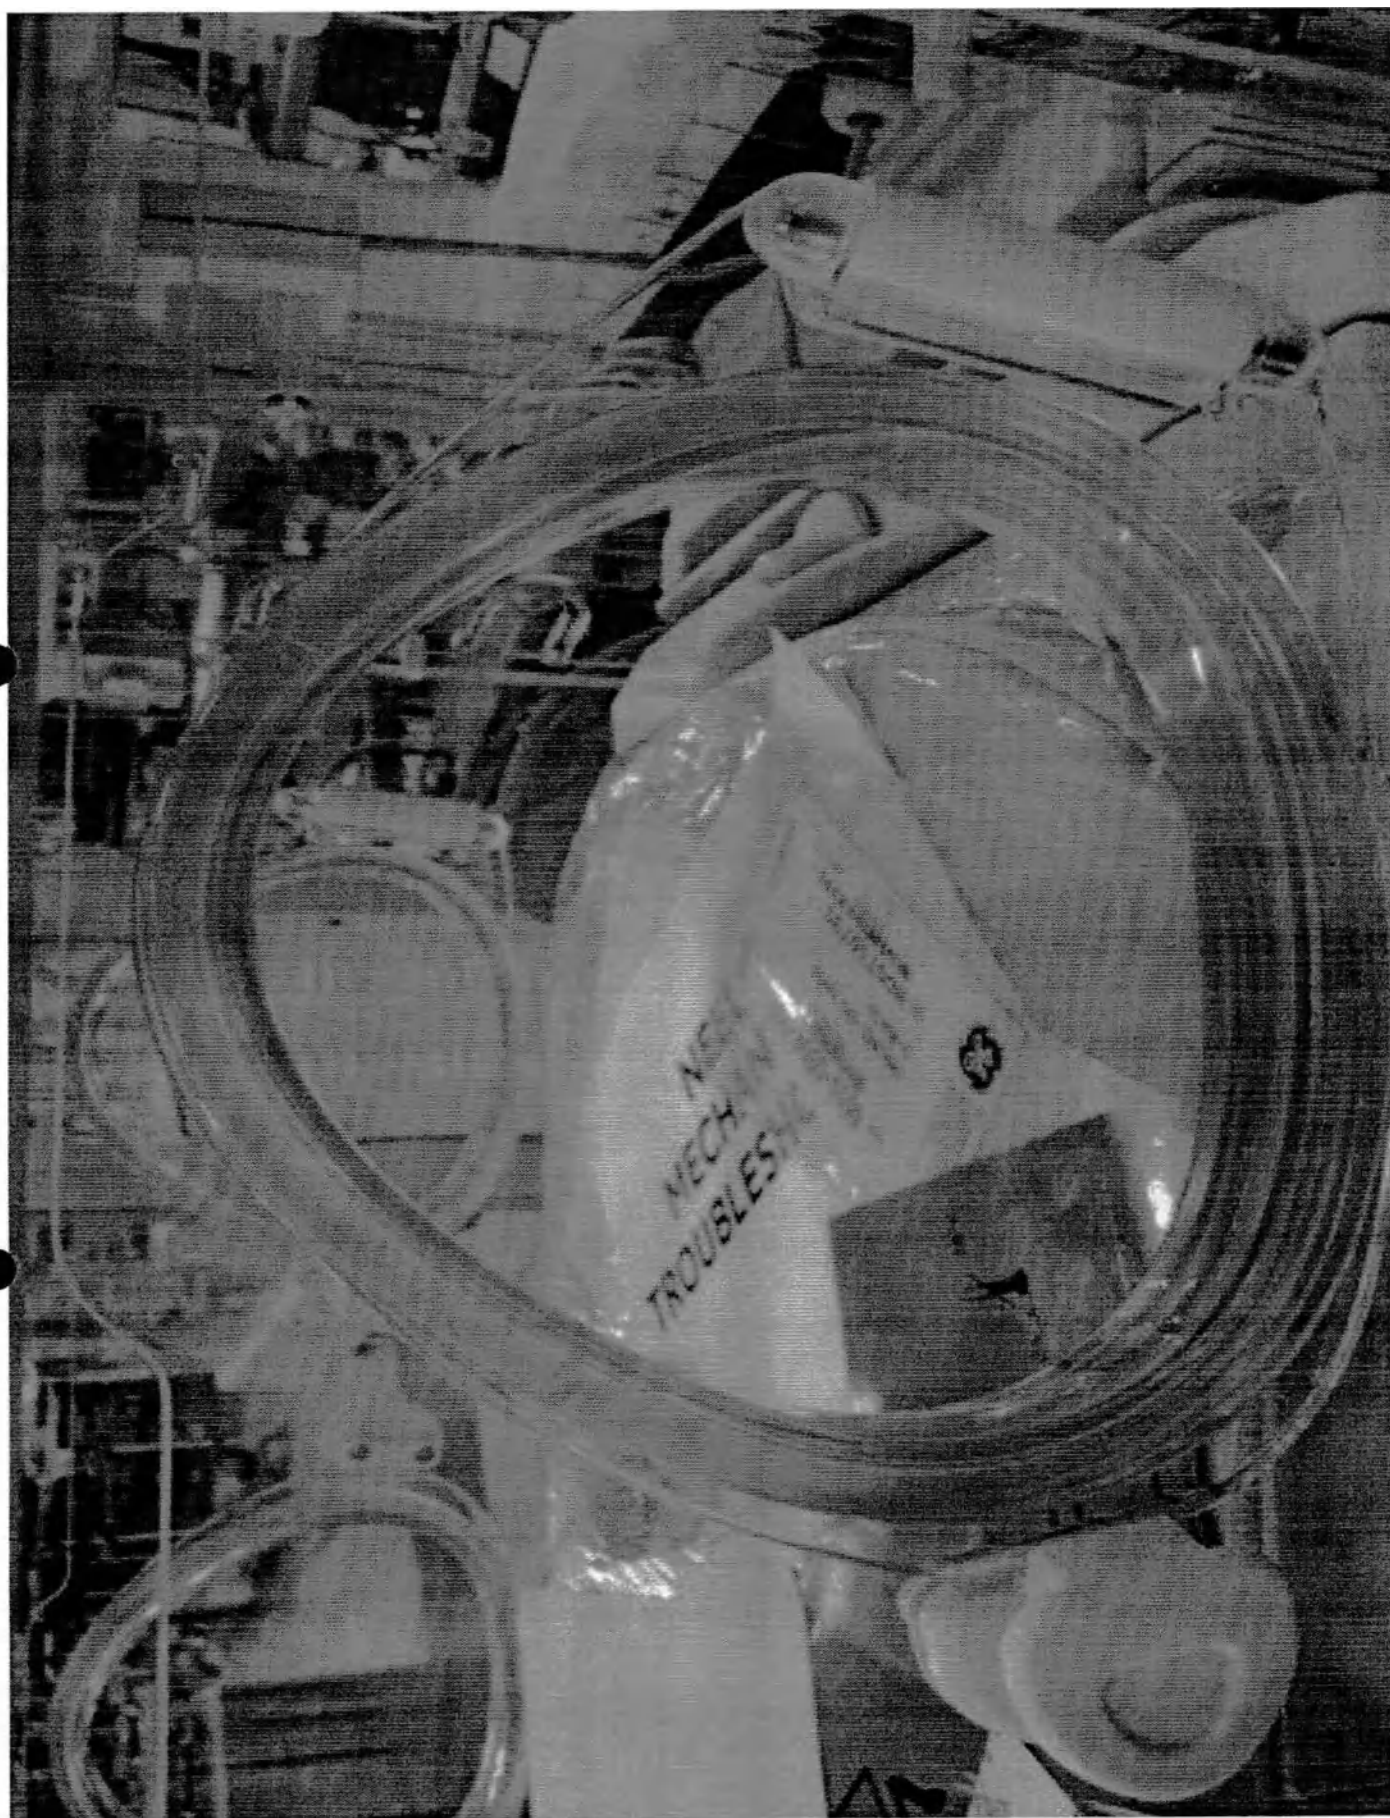

52. Зажимы крепежные для фиксации приборов, не более 5 шт.

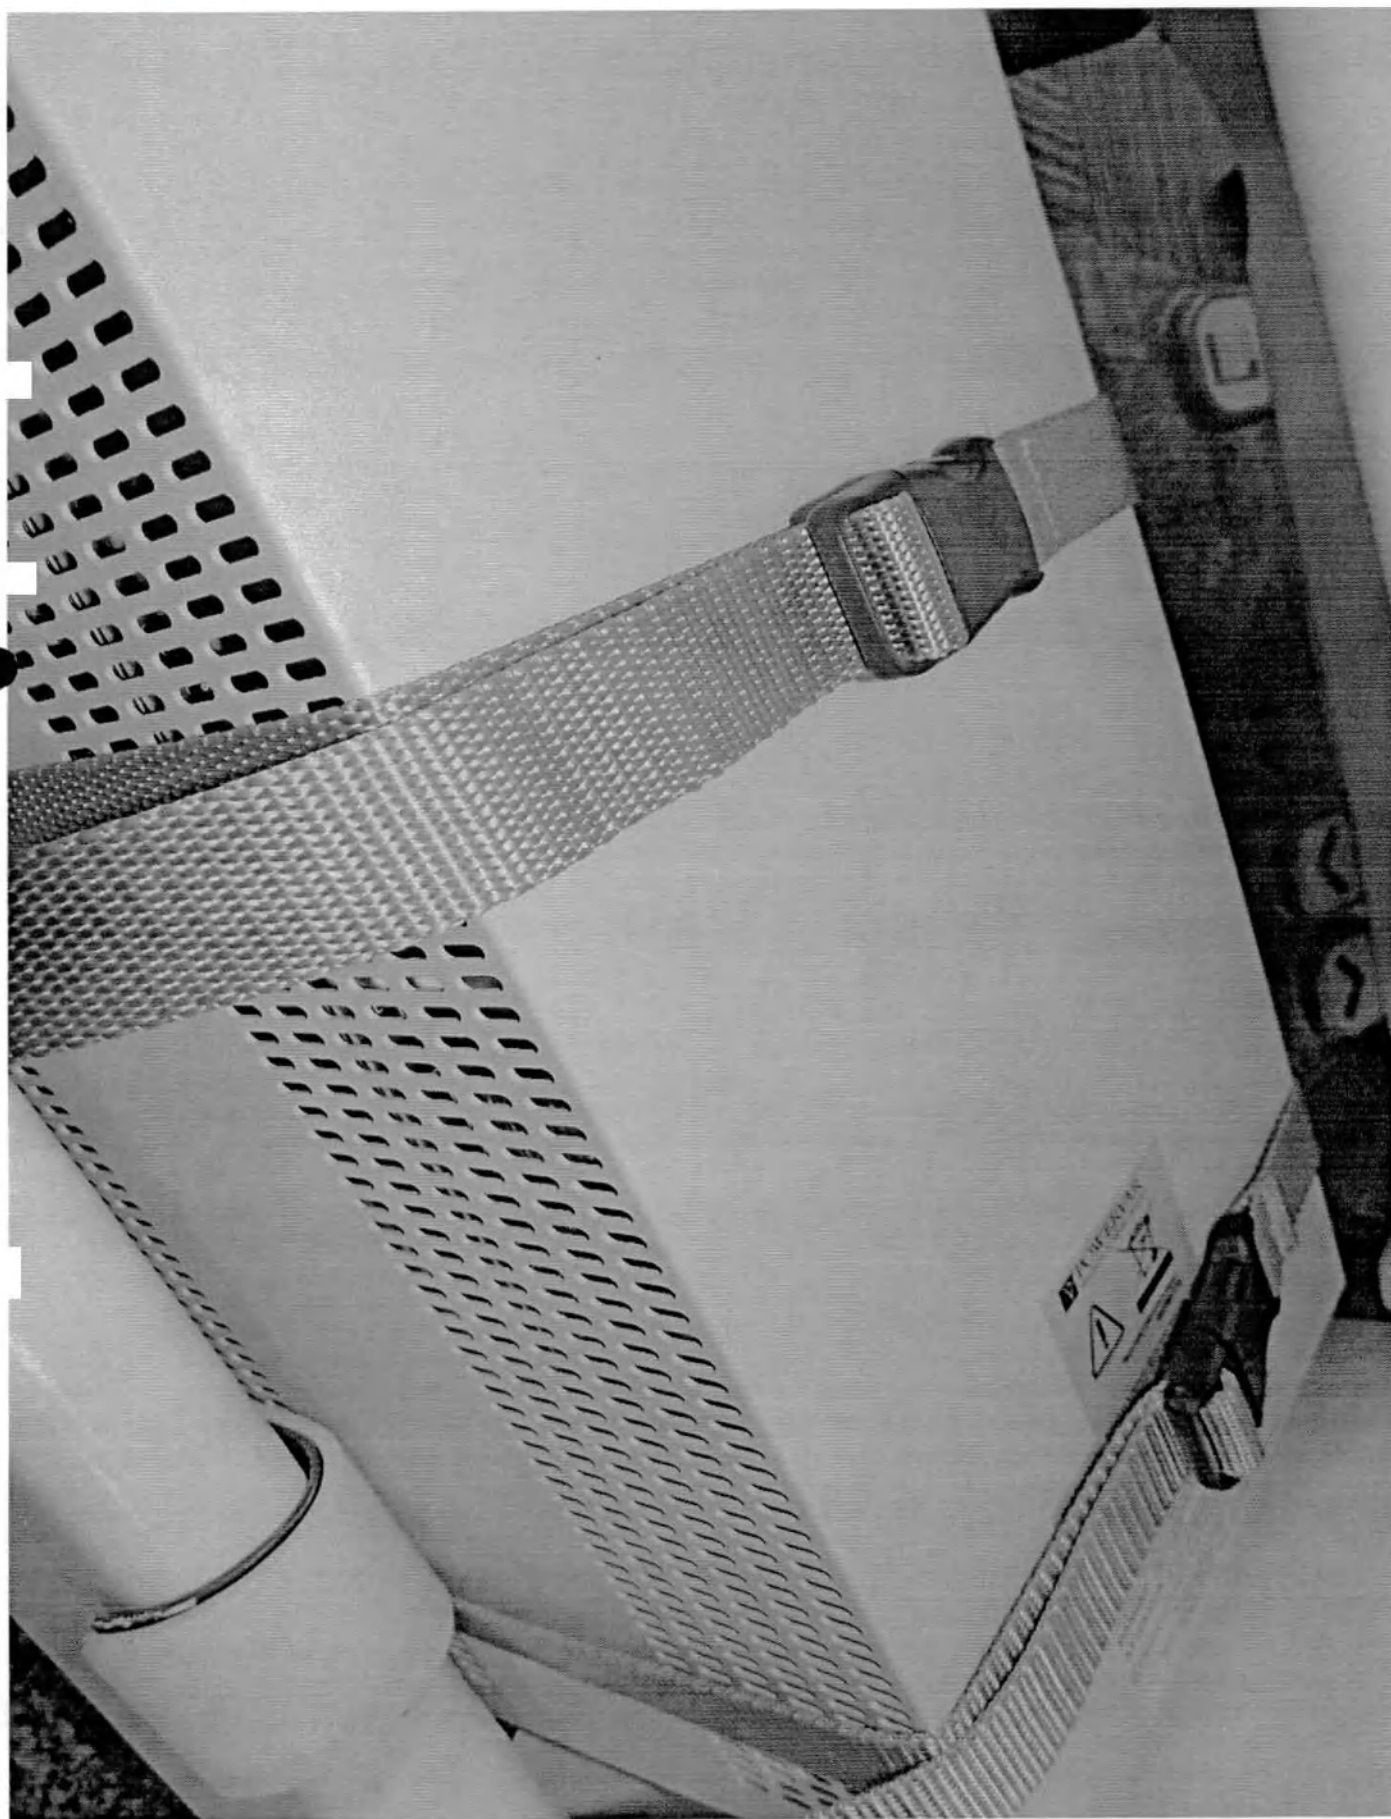



53. Уплотнители углов для портов, не более 20 шт.



54. Крепления, варианты исполнения:

54.1. Крепление для аппарата ИВЛ, не более 10 шт.,

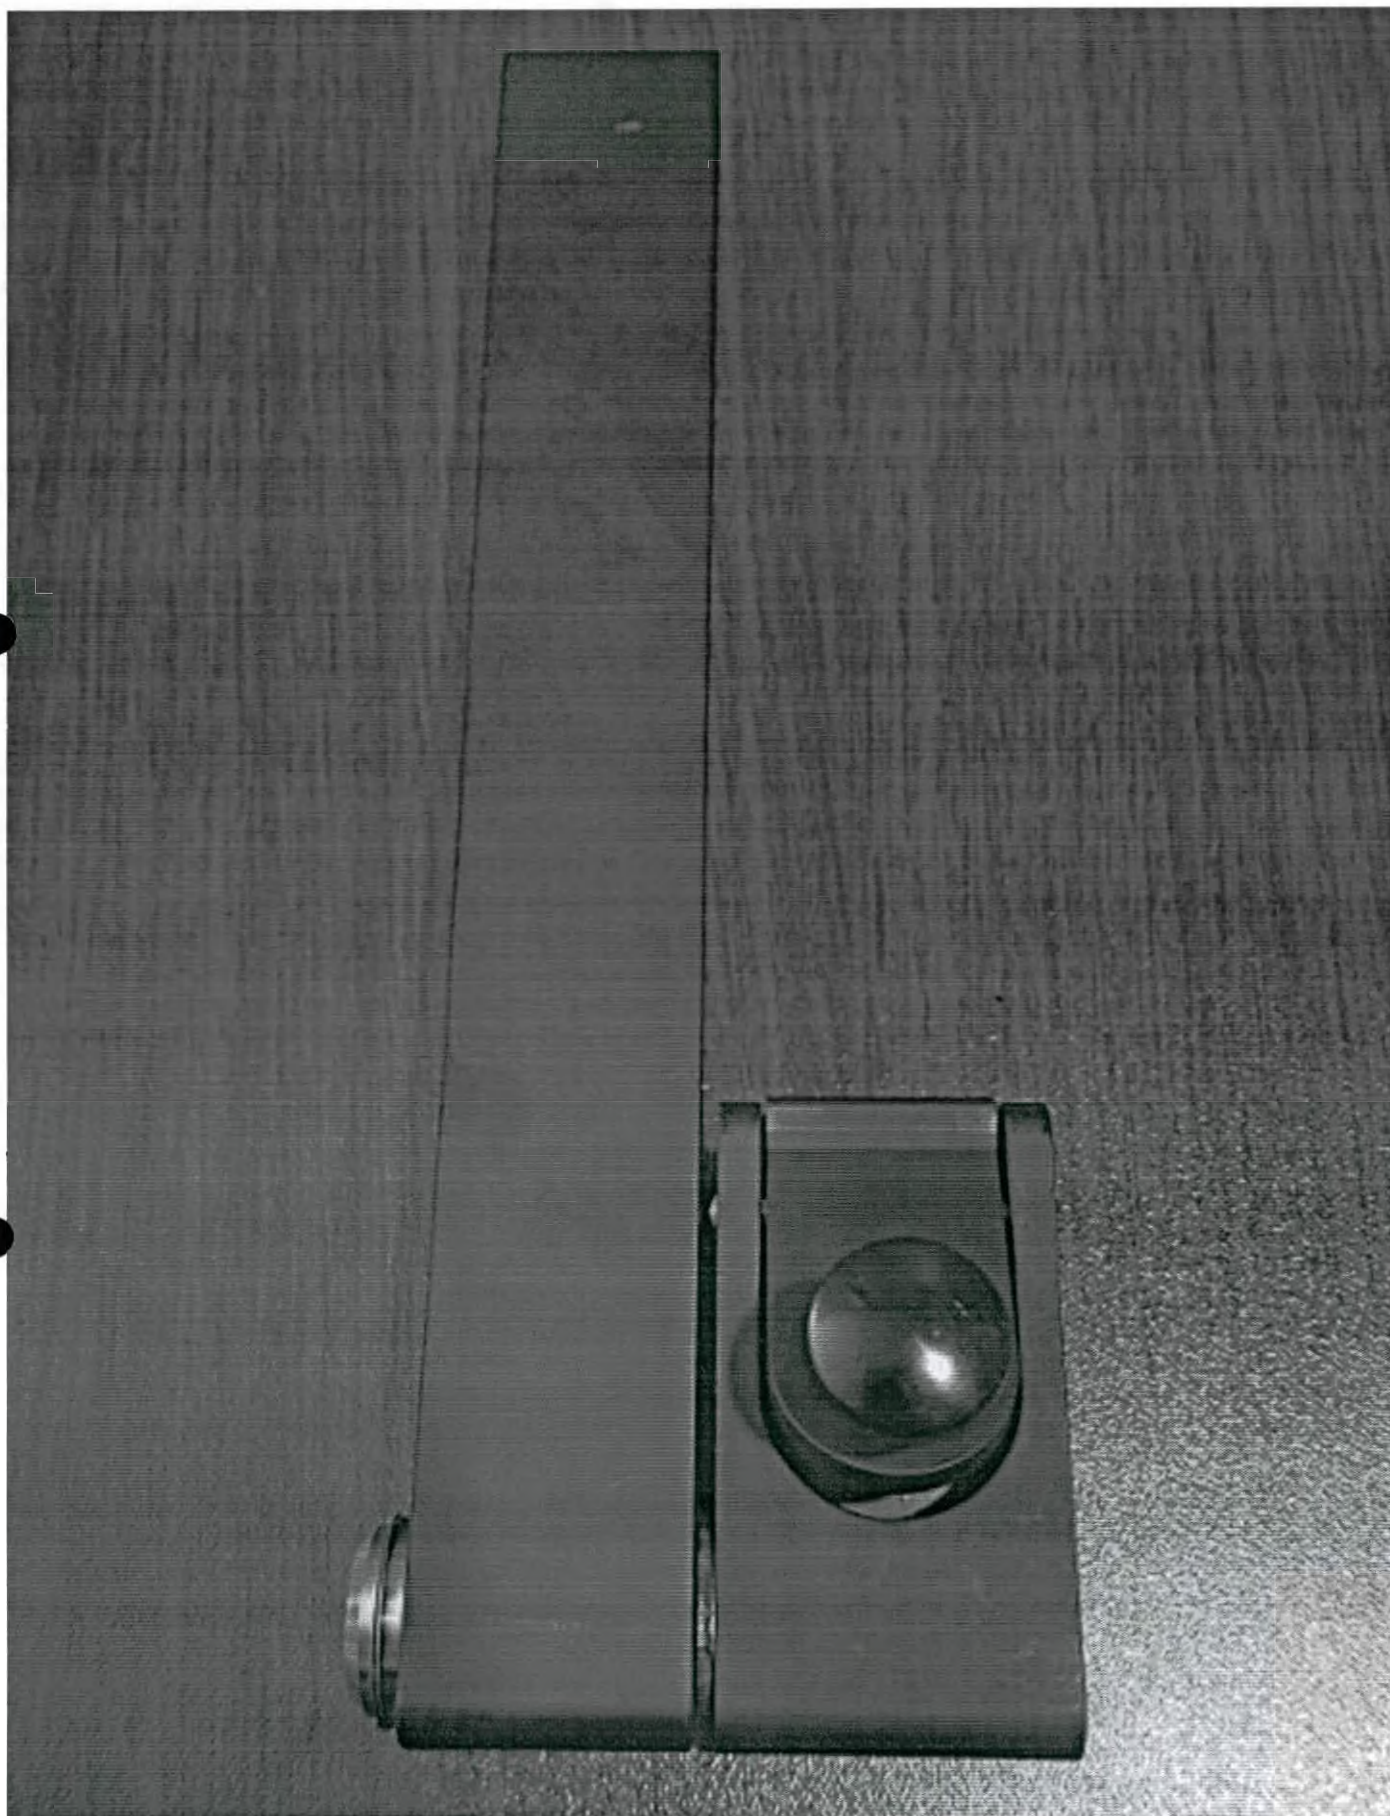


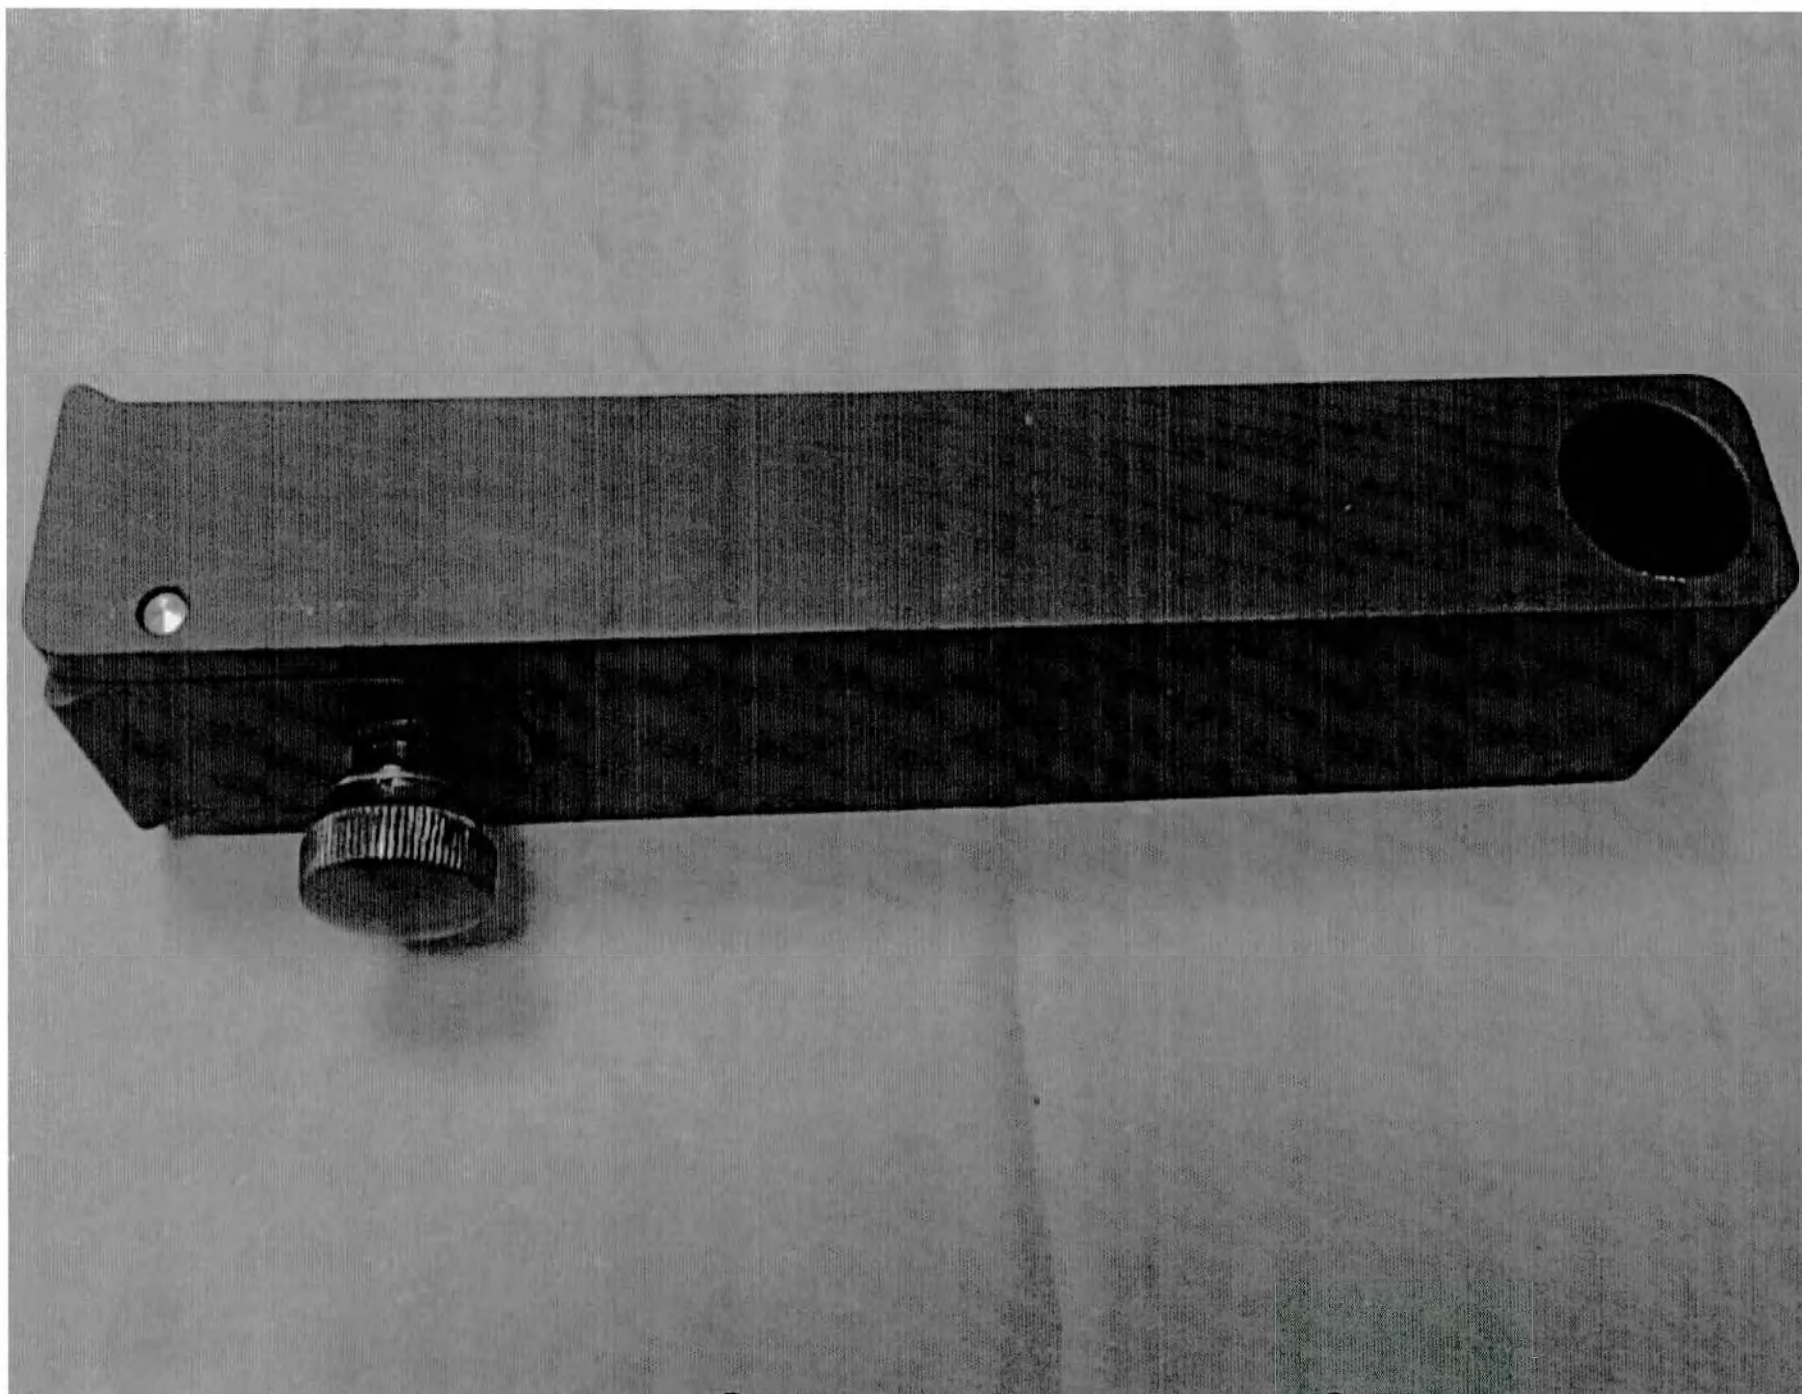


54.2.Крепление для удобного маневрирования оборудованием во время транспортировки, не более 10 шт.,




54.3.Крепление для принадлежностей, не более 10 шт.,

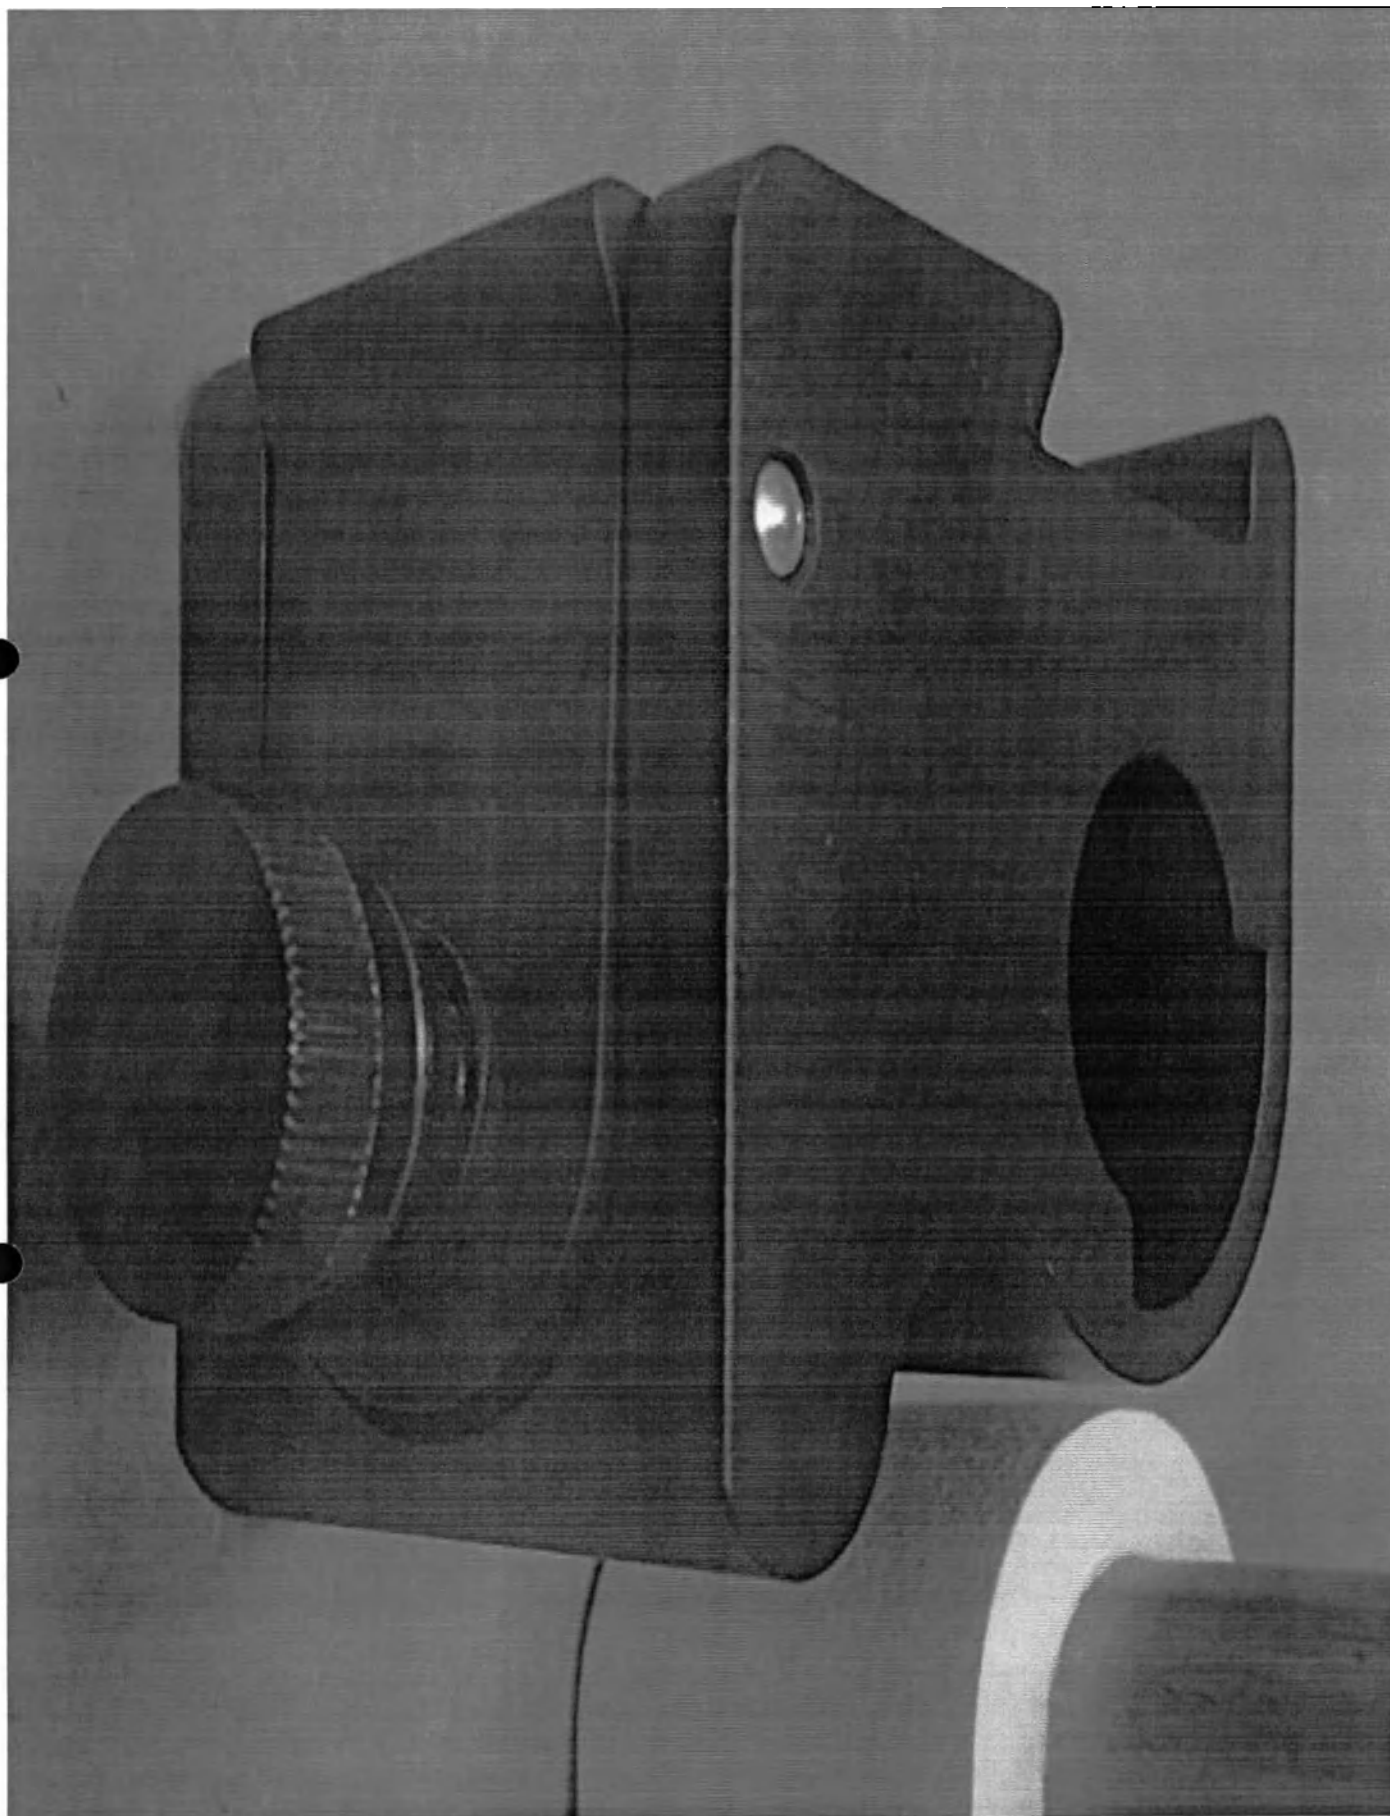


54.4. Крепление для кабелей, не более 10 шт.

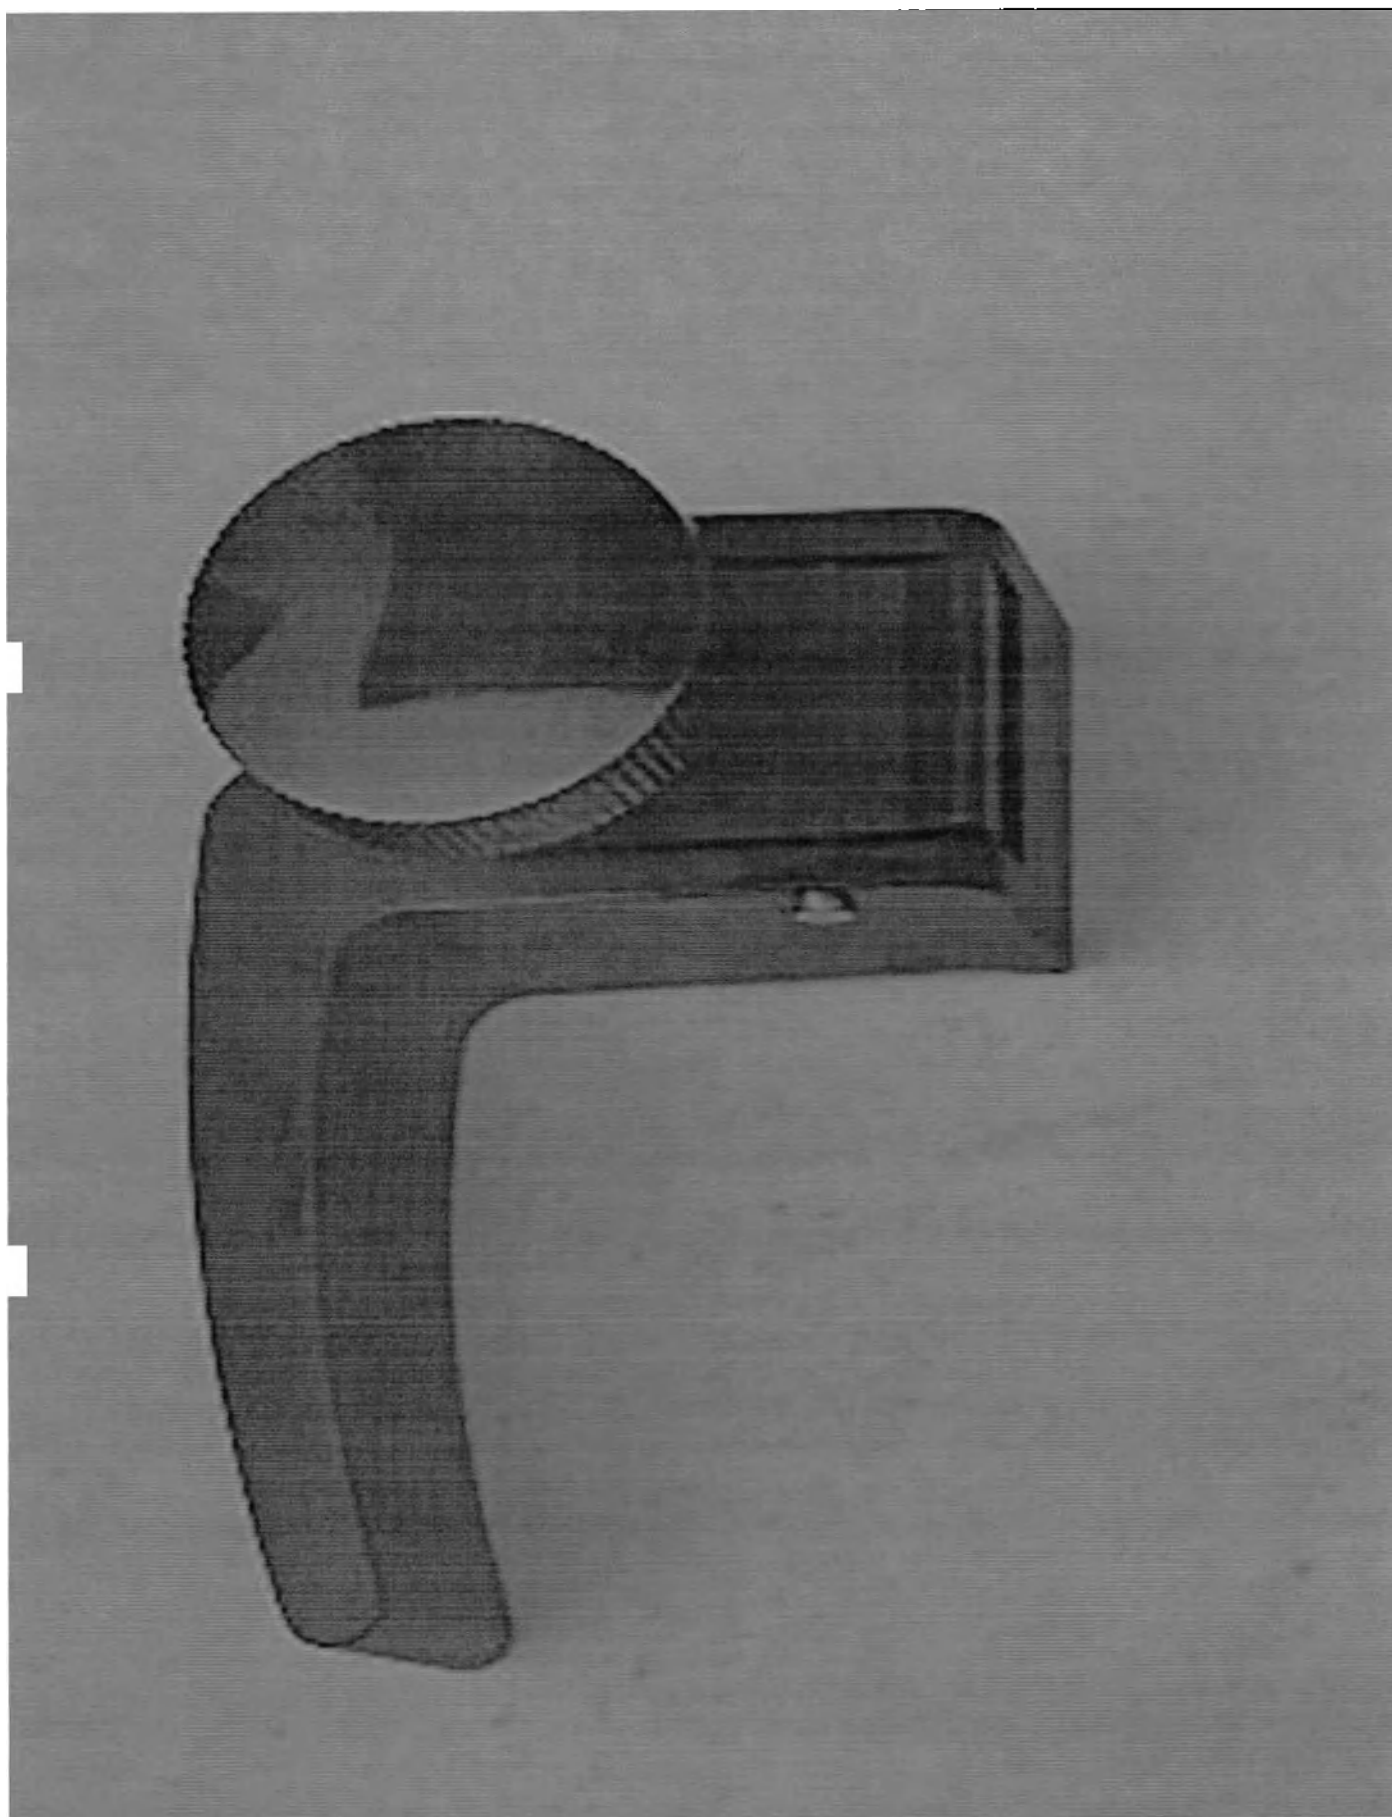

55. Фильтры бактериальные для очистки воздуха, не более 100 шт.

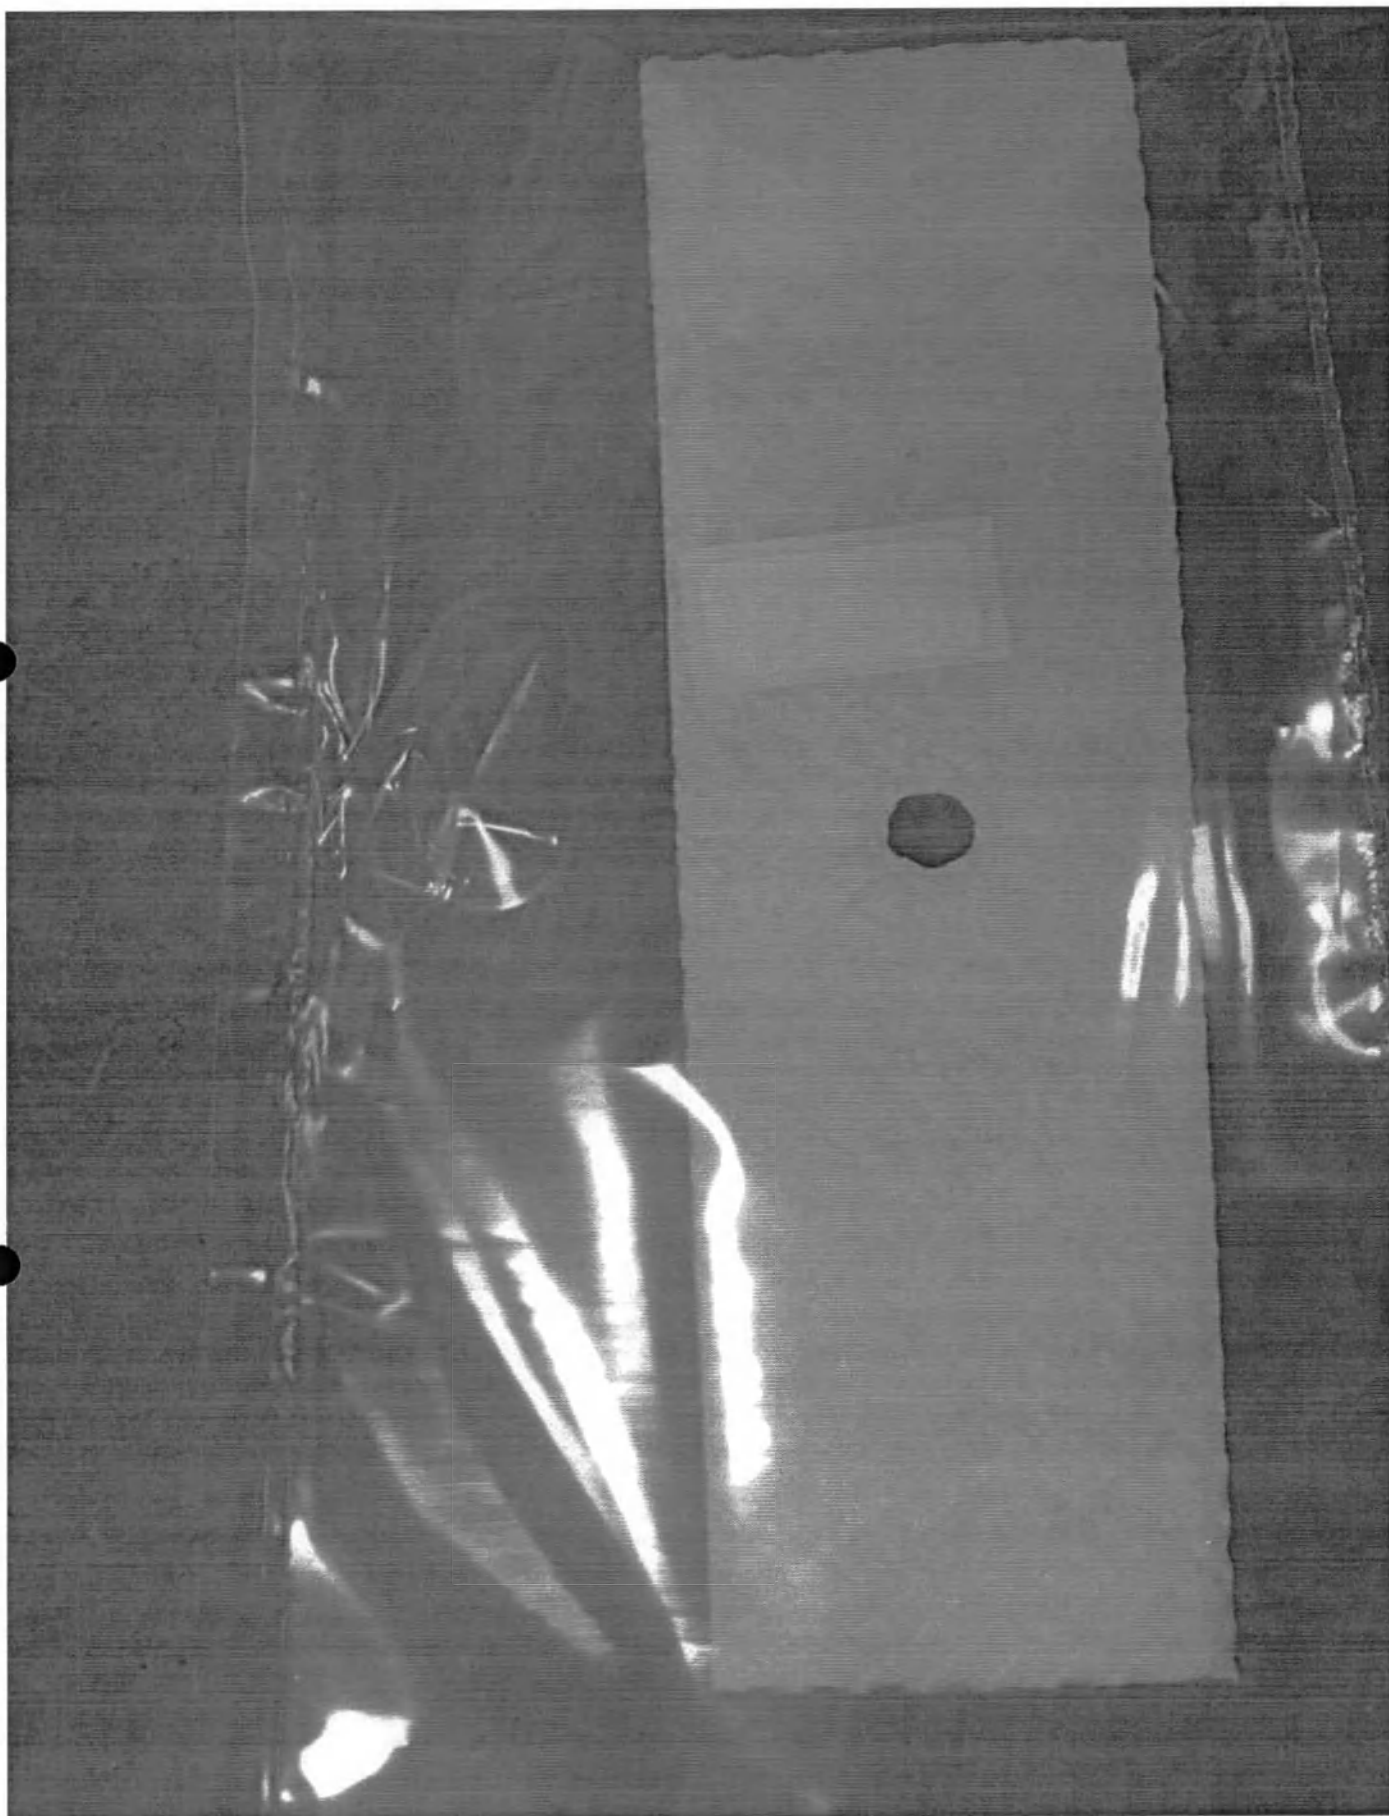

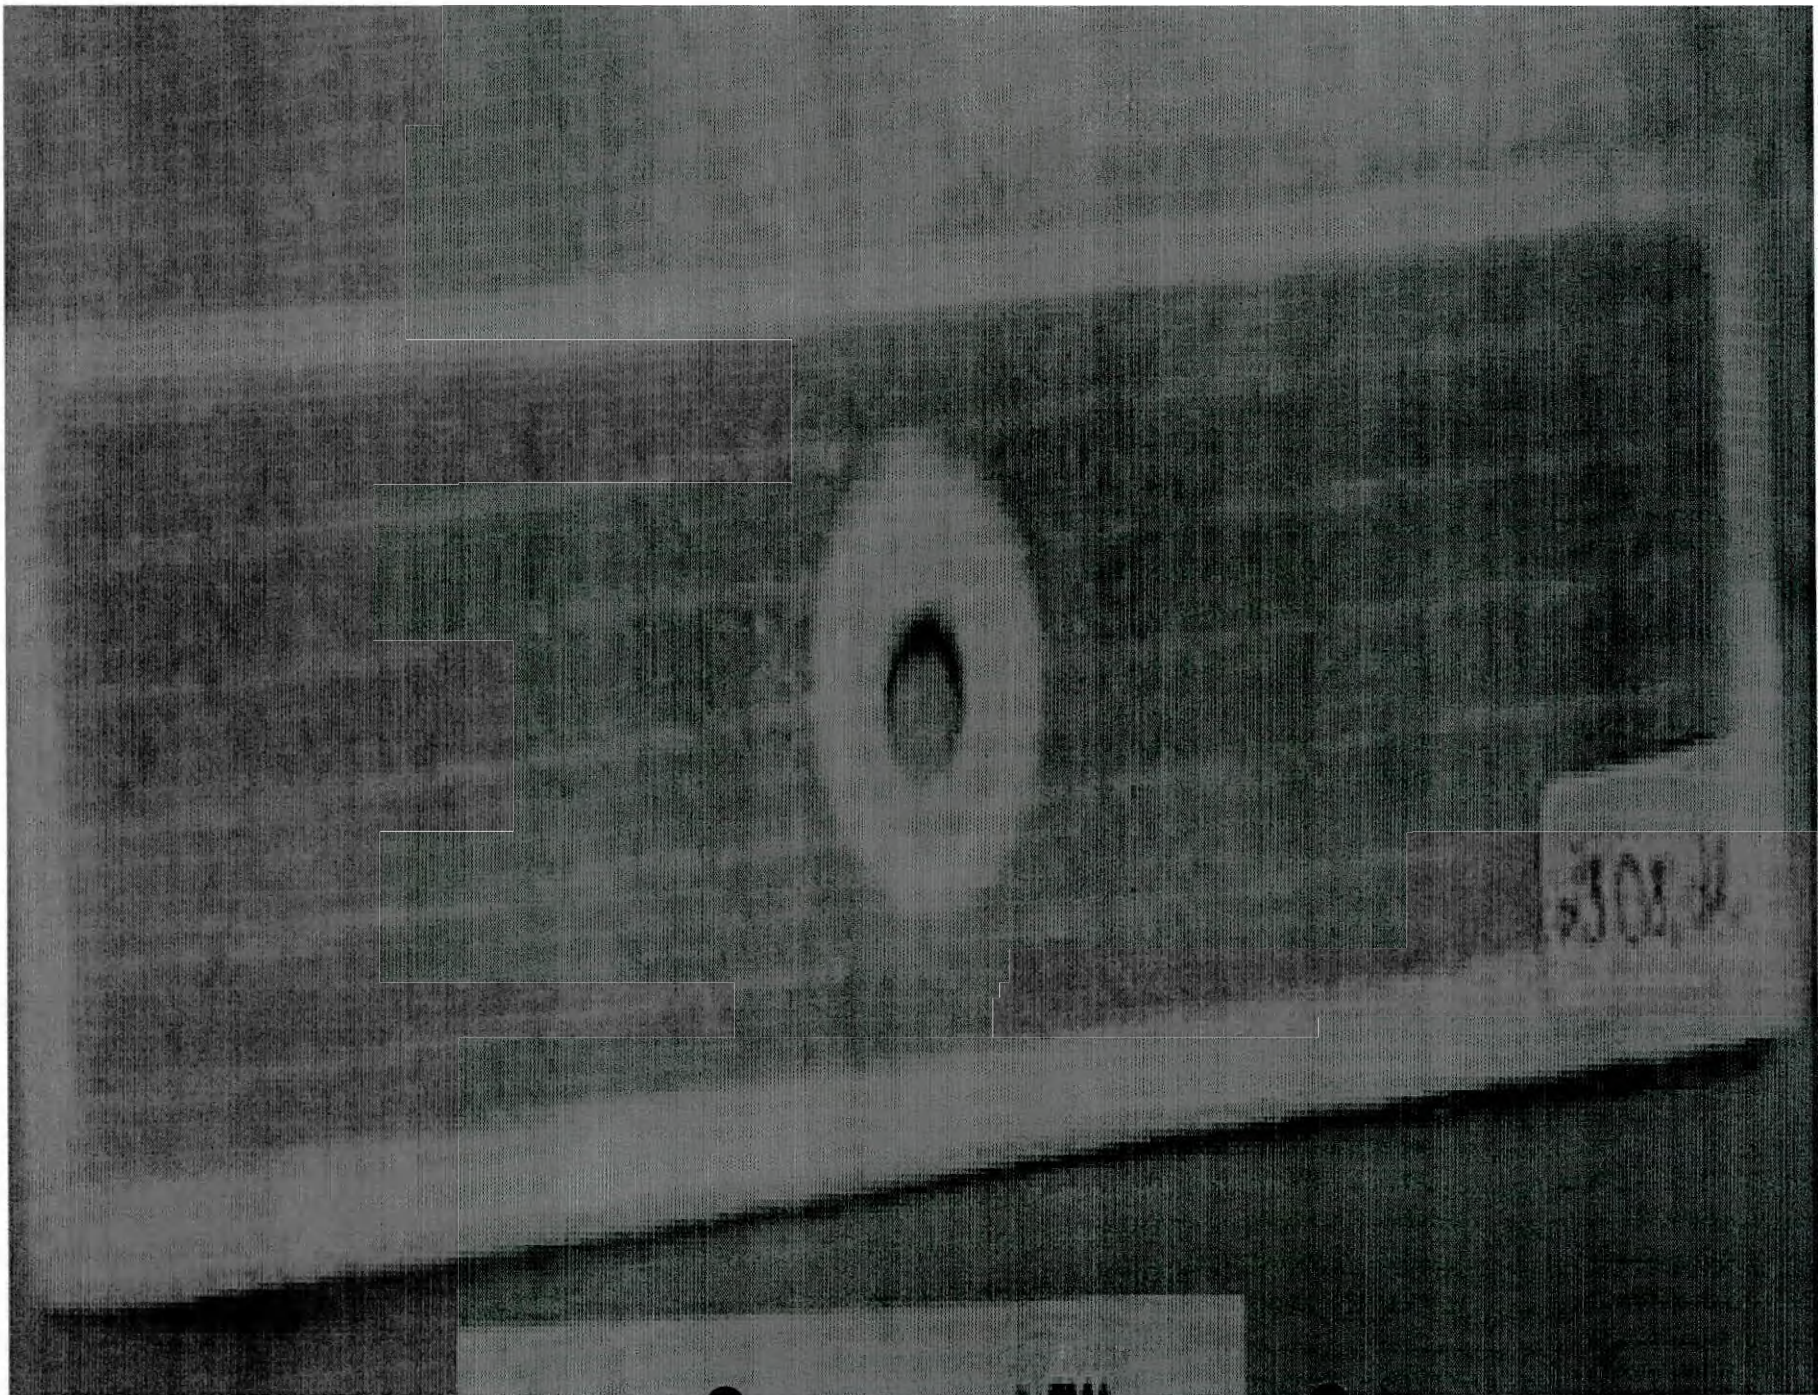

56. Рейки для расположения принадлежностей, не более 5 шт.





Handwritten signature in blue ink.

ПРОШНО
И
ПРОУМЕРОВАНО
В ЛИСТО

