




Макеты маркировки



Комплекс реанимационный открытый Giraffe Warmer
с принадлежностями


Директор департамента Регистрации
и Сертификации, Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

 А. П. Харитоновна
«27» декабря 2022 г.

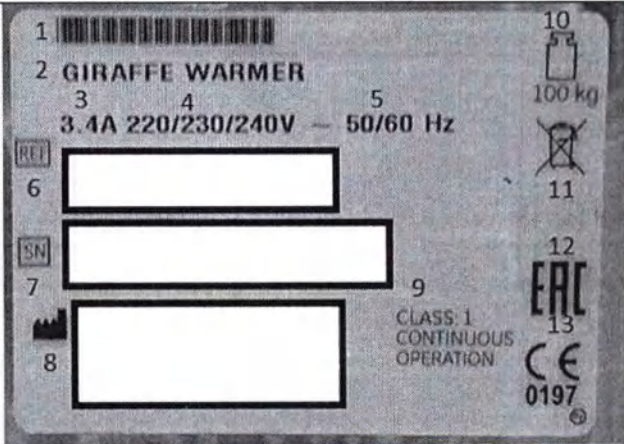

Наименование компонента	Пример маркировки			
Комплекс реанимационный открытый Giraffe Warmer				
	1	Штрихкод	8	Наименование производителя и/или адрес производителя
	2	Торговое наименование	9	Класс защиты от поражения электрическим током I, продолжительный режим работы
	3	Сила тока	10	Масса
	4	Напряжение сети питания	11	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования
	5	Частота сети питания	12	Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС
	6	Каталожный номер	13	Знак CE и код органа сертификации
	7	Серийный номер		
UDI:  (01)  (21)  (11)   YYYY-MM-DD				
Пример маркировки UDI и даты изготовления (выпуска) МИ				
 MAX 2A @ 115v~, 50/60 Hz MAX 1A @ 220-240v~, 50/60 Hz				
Пример маркировки рядом с розетками для дополнительных устройств				
				
Пример маркировки максимального номинального давления, создаваемого внешним источником				

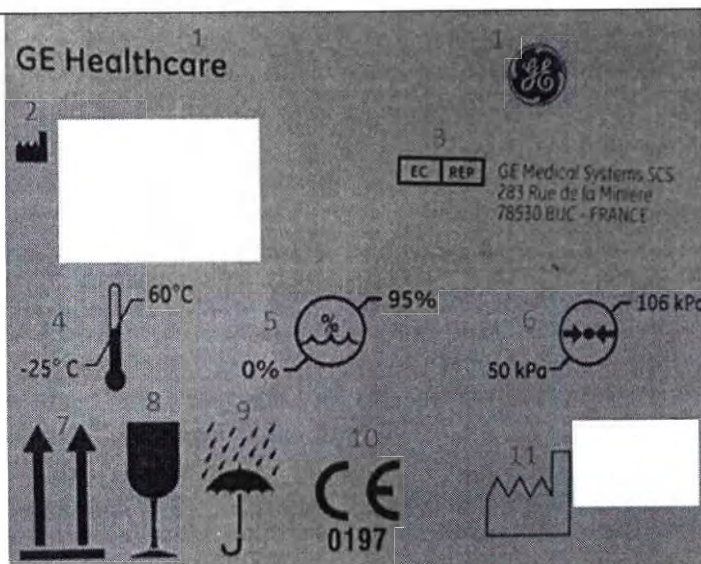


Пример маркировки транспортной тары МИ

1	Наименование и логотип компании	7	Вверх
2	Наименование производителя и/или адрес производителя	8	Хрупкое, обращаться осторожно
3	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе	9	Беречь от влаги
4	Температурный диапазон, при котором МИ надежно сохраняется	10	Знак СЕ и код органа сертификации
5	Диапазон влажности, при котором МИ надежно сохраняется	11	Дата изготовления
6	Ограничение атмосферного давления, при котором МИ надежно сохраняется		

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Датчики температурные многоразовые, производитель CareFusion Finland 320 ОУ, Финляндия

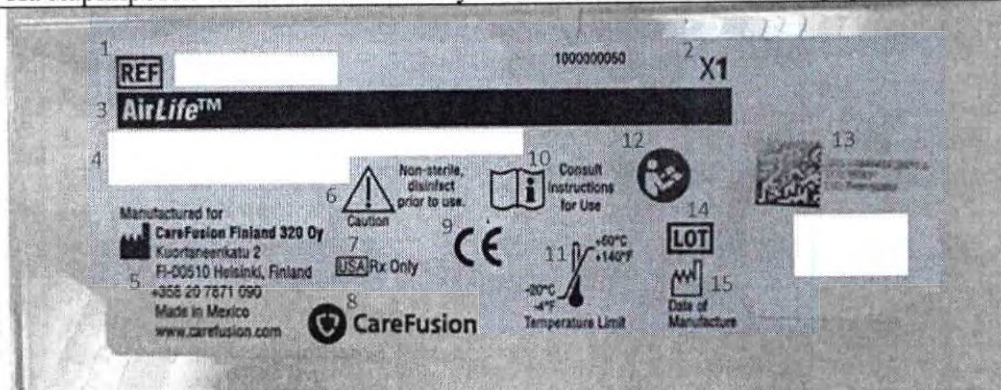


1	Каталожный номер	9	Знак СЕ
2	Количество штук в упаковке	10	Обратитесь к инструкции по применению

3	Торговая марка	11	Температурный диапазон, при котором изделие надежно сохраняется
4	Наименование изделия	12	Обратитесь к инструкции
5	Наименование производителя и/или адрес производителя	13	Символ UDI (Уникальная идентификационная метка)
6	Внимание! Не стерильно, перед применением необходимо продезинфицировать	14	Код партии
7	Только для США. Наклейка с требованием продажи только по предписанию врача	15	Дата производства
8	Наименование и логотип компании		

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Датчики температурные одноразовые, производитель Vyair Medical INC, США

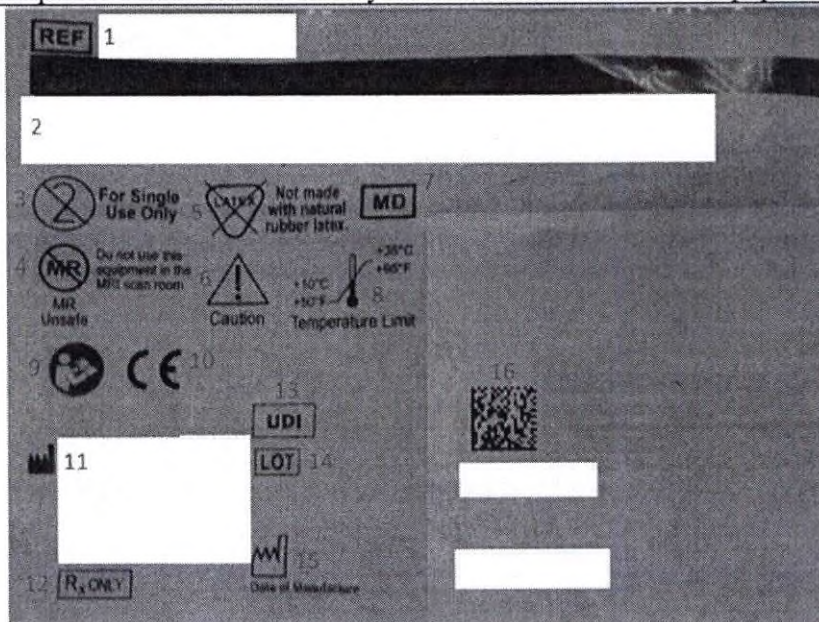


1	Каталожный номер	9	Обратитесь к инструкции
2	Наименование изделия	10	Знак CE
3	Запрет на повторное применение	11	Наименование производителя и/или адрес производителя
4	Не использовать изделие в помещении, где установлено оборудование для проведения магнитно-резонансной томографии	12	Только для США. Наклейка с требованием продажи только по предписанию врача
5	Сделано без использования латекса	13	Символ UDI (Уникальная идентификационная метка)
6	Осторожно! Обратитесь	14	Номер партии

	к инструкции по применению		
7	Медицинское изделие	15	Дата производства
8	Температурный диапазон, при котором изделие надежно сохраняется	16	Штрихкод

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Датчики
пульсоксиметрические
многоцветные,
производитель
Masimo CORP, США

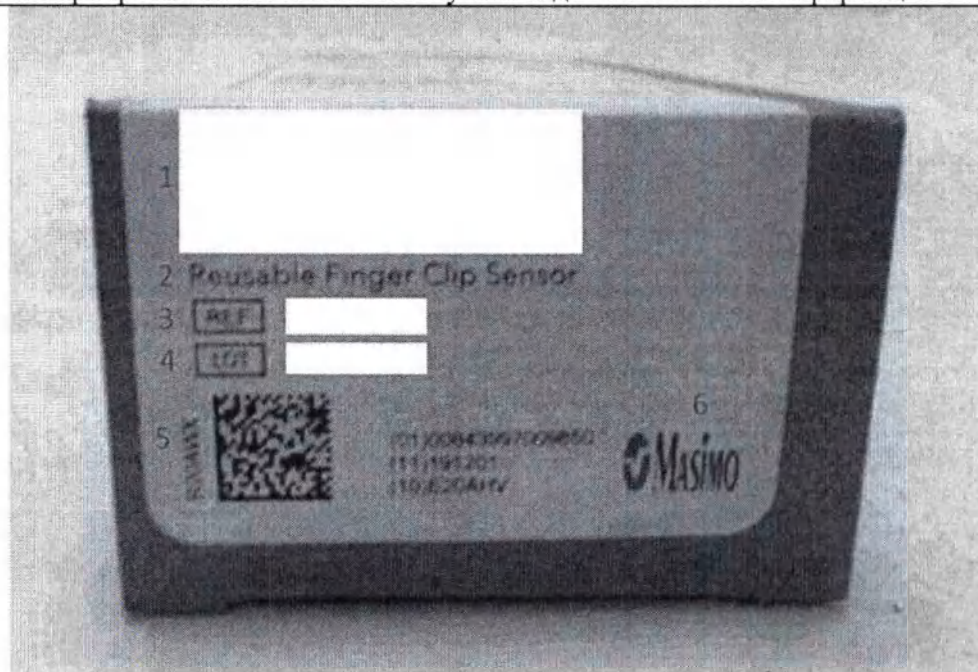


1	Каталожный номер	4	Номер партии
2	Наименование изделия	5	Уникальный идентификатор (UDI)
3	Каталожный номер	6	Наименование и логотип компании

Примечание:


На маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Датчики
пульсоксиметрические
одноразовые,
производитель
Masimo CORP, США

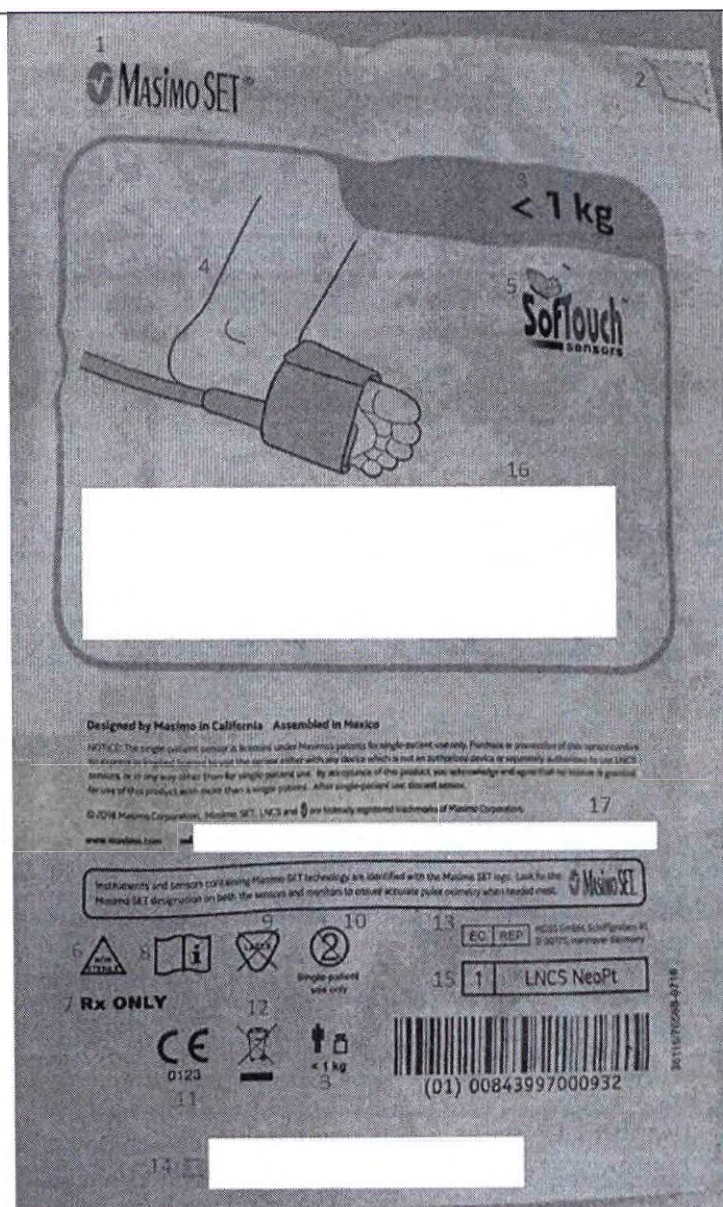

1	Датчик предназначен для использования только с устройствами, применяющими систему оксиметрии Masimo SET	10	Запрет на повторное применение
2	Открыть здесь	11	Знак CE и код органа сертификации
3	Подходит для пациентов с массой тела менее 1 кг	12	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования
4	Пример использования пульсоксиметрического датчика	13	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
5	Датчик мягкого прикосновения	14	Использовать до
6	Не стерильно	15	Артикул
7	Только для США. Наклейка с	16	Наименование изделия

	требованием продажи только по предписанию врача		
8	Обратитесь к инструкции по применению	17	Наименование производителя и/или адрес производителя
9	Сделано без использования латекса		

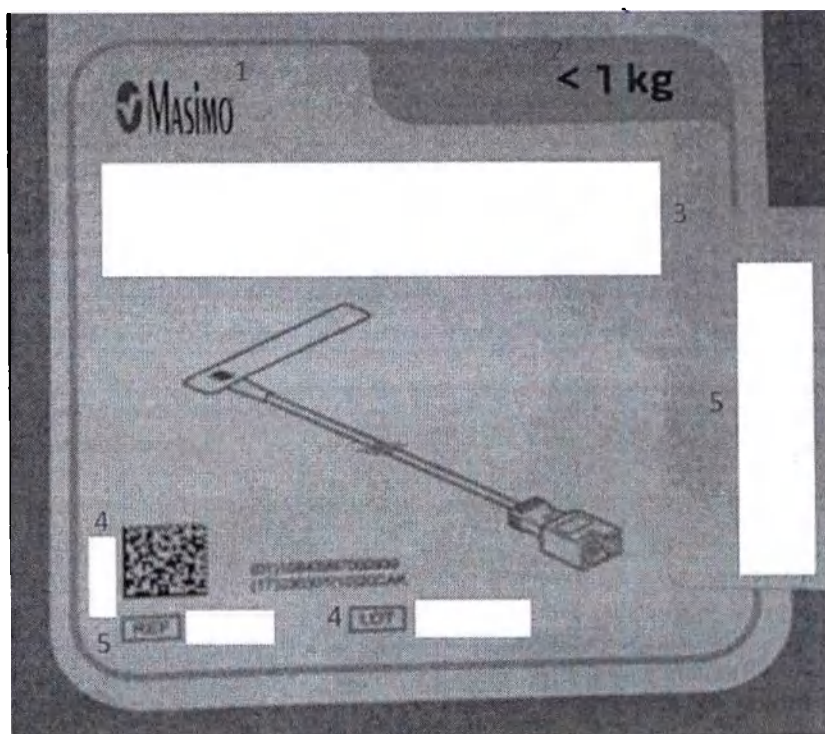


1	Торговый знак компании Masimo
2	Подходит для пациентов с массой тела менее 1 кг
3	Наименование изделия
4	Номер партии
5	Каталожный номер

Примечание:


На маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Лампа фототерапии со световодом, производитель Lumitex, США

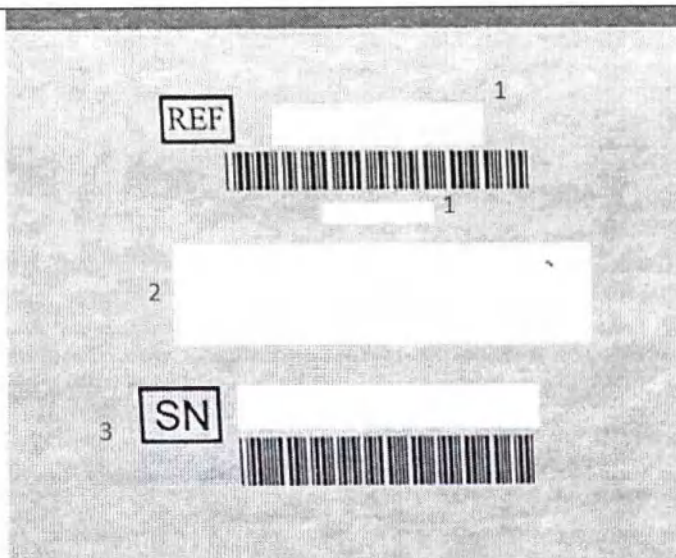

Пример информации, содержащейся на транспортной упаковке

1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Серийный номер

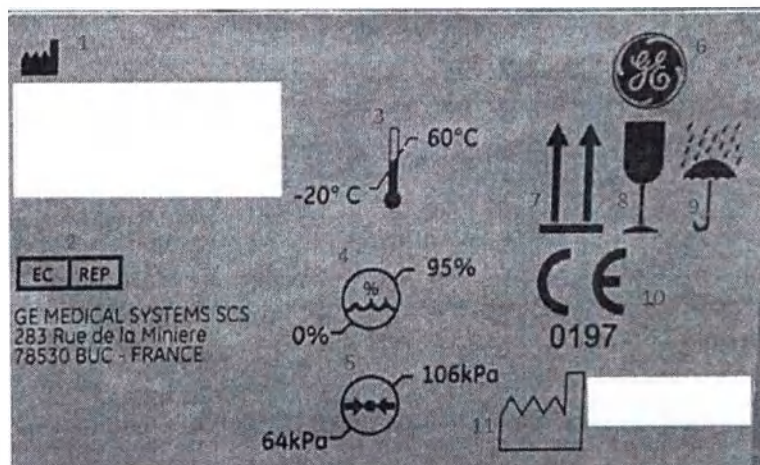

Пример информации, содержащейся на транспортной упаковке


1	Наименование производителя и/или адрес производителя	7	Вверх
2	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе	8	Хрупкое, обращаться с осторожностью
3	Температурный диапазон, при котором изделие надежно сохраняется	9	Беречь от влаги
4	Диапазон влажности, при котором изделие надежно сохраняется	10	Знак CE и код органа сертификации
5	Ограничение атмосферного давления, при котором изделие надежно сохраняется	11	Дата производства
6	Наименование и логотип		

	компаний		
--	----------	--	--

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Электронные весы,
производитель Datex-
Ohmeda Inc., США

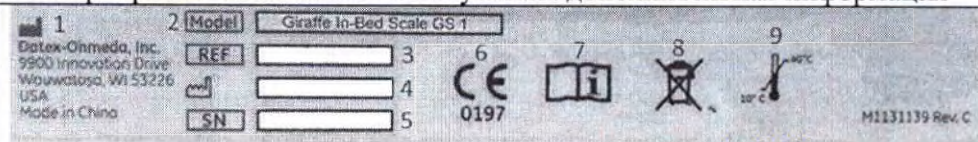


1	Наименование производителя и/или адрес производителя	6	Знак CE и код органа сертификации
2	Модель	7	Обратитесь к инструкции по применению
3	Каталожный номер	8	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования
4	Дата производства	9	Температурный диапазон, при котором изделие надежно сохраняется
5	Серийный номер		

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Инфузионные стойки,
производитель GE
Healthcare

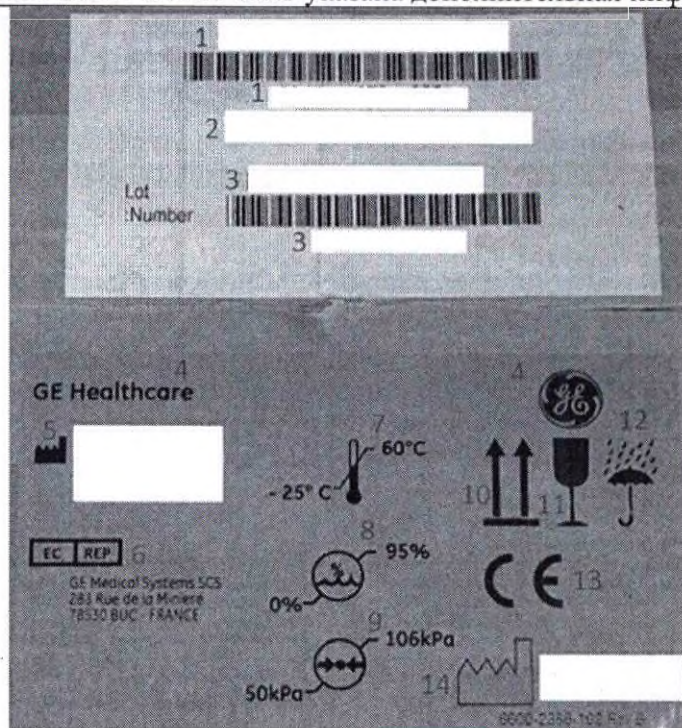


1	Каталожный номер	8	Диапазон влажности, при котором изделие надежно сохраняется
2	Наименование изделия	9	Ограничение атмосферного давления, при котором изделие надежно сохраняется
3	Номер партии	10	Вверх

3	Номер партии	10	Вверх
4	Наименование и логотип компании	11	Хрупкое, обращаться осторожно
5	Наименование производителя и/или адрес производителя	12	Беречь от влаги
6	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе	13	Знак CE
7	Температурный диапазон, при котором изделие надежно сохраняется	14	Дата производства

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Контуры пациента,
производитель
Flexicare Medical
Limited, США

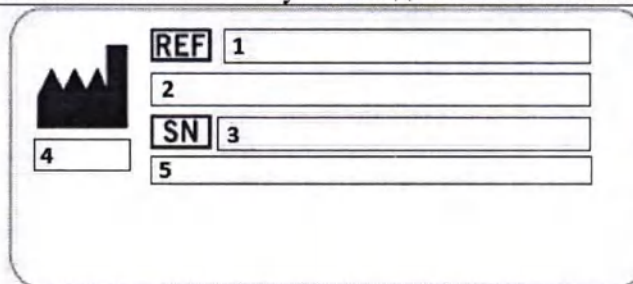


The diagram shows a rectangular area representing a marking label. On the left is a barcode icon. To its right are two rows of input fields. The first row is labeled 'REF' and contains a field with the number '1'. The second row is labeled 'SN' and contains a field with the number '3'. Below the barcode icon is a field with the number '4'. To the right of the 'SN' field is another field with the number '5'.

1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Серийный номер
4	Наименование производителя и/или адрес производителя
5	Страна производства

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

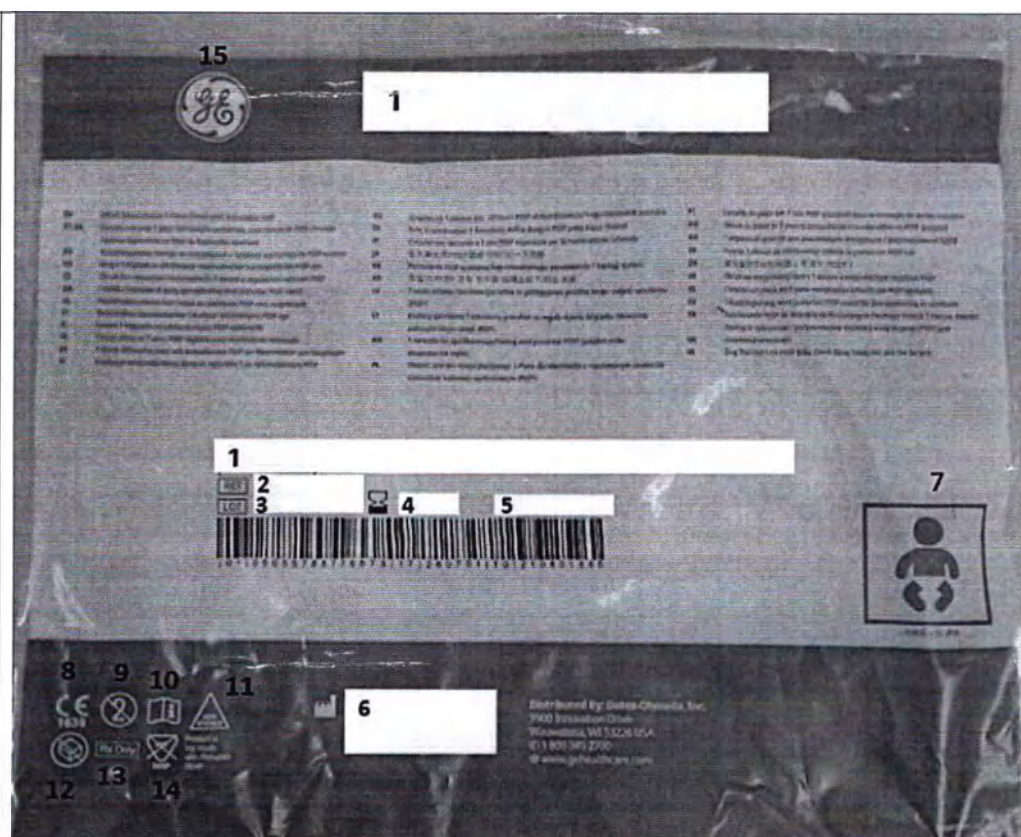


1	Наименование изделия	9	Запрет на повторное применение
2	Каталожный номер	10	Обратитесь к инструкции по применению
3	Серийный номер	11	Не стерильно
4	Использовать до	12	Не использовать при повреждении упаковки
5	Страна производства	13	Только для США. Наклейка с требованием продажи только по предписанию врача
6	Наименование производителя и/или адрес производителя	14	Сделано без использования латекса
7	Ребенок	15	Наименование и логотип компании
8	Знак CE и код органа сертификации		

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация


Флоуметры (для подачи кислорода),
производитель GE Healthcare

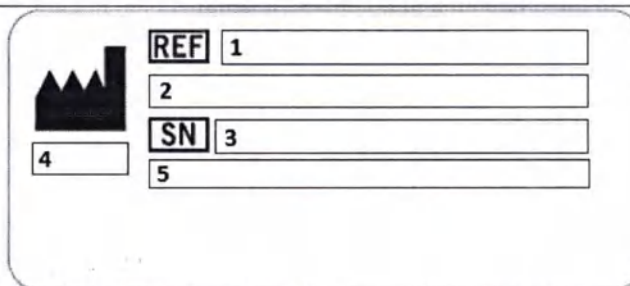

1 REF 1
2
3 SN 3
4
5

1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Серийный номер
4	Наименование производителя и/или адрес производителя
5	Страна производства
	Примечание: На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Матрасики, производитель GE Healthcare, США.

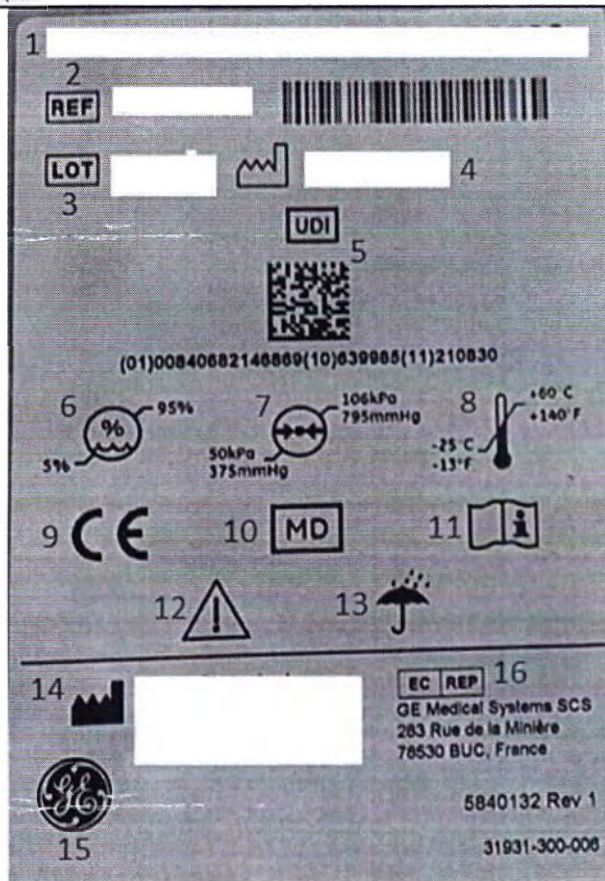

1
2 REF
3 LOT
4
5 UDI
6 95%
7 106kPa 795mmHg
8 +60 C +140 F
9 CE
10 MD
11
12
13
14
15
16 EC REP
GE Medical Systems SCS
263 Rue de la Minière
78530 BUC, France
5840132 Rev 1
31931-300-008


1	Наименование изделия	9	Знак CE
2	Каталожный номер	10	Медицинское изделие
3	Номер партии	11	Обратитесь к инструкции по применению
4	Дата производства	12	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
5	Уникальный идентификатор (UDI)	13	Беречь от влаги
6	Диапазон влажности, при	14	Наименование производителя

	котором изделие надежно сохраняется		и/или адрес производителя
7	Ограничение атмосферного давления, при котором изделие надежно сохраняется	15	Наименование и логотип компании
8	Температурный диапазон, при котором изделие надежно сохраняется	16	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Укладки-гнездышки для новорожденных, производитель Lumitex, США

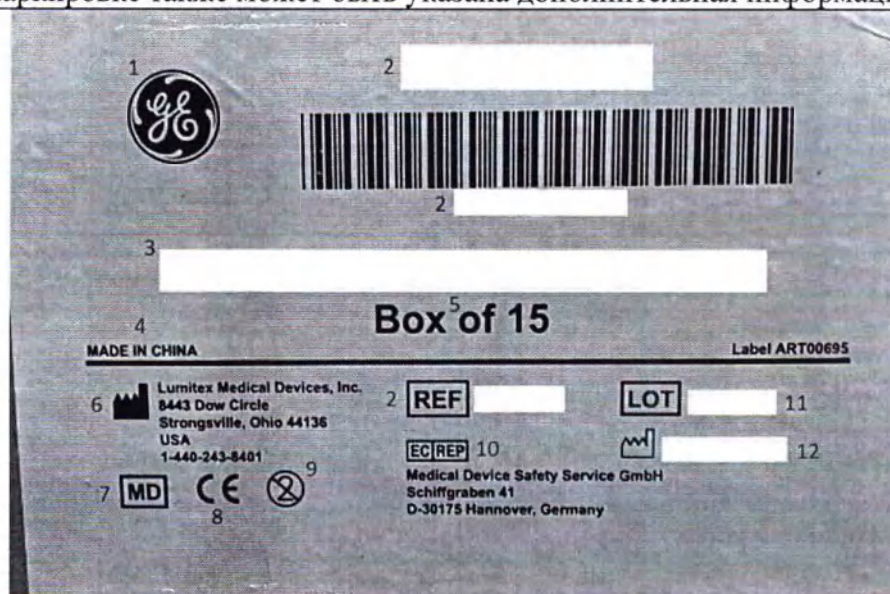


1	Наименование и логотип компании	7	Медицинское изделие
2	Каталожный номер	8	Знак CE
3	Наименование изделия	9	Запрет на повторное применение
4	Сделано в Китае	10	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
5	Коробка из 15 шт.	11	Код партии
6	Наименование производителя и/или адрес производителя	12	Дата производства

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Полки
инструментальные

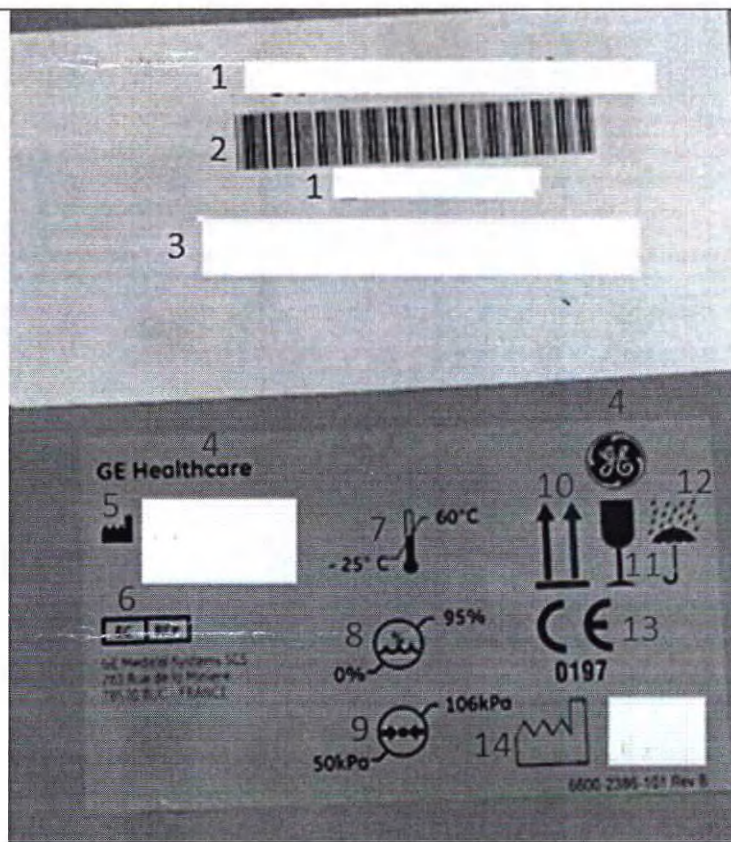


1	Каталожный номер	8	Диапазон влажности, при котором изделие надежно сохраняется
2	Штрихкод	9	Ограничение атмосферного давления, при котором изделие надежно сохраняется
3	Наименование изделия	10	Вверх
4	Наименование и логотип компании	11	Хрупкое, обращаться осторожно
5	Наименование производителя и/или адрес производителя	12	Беречь от влаги
6	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе	13	Знак CE и код органа сертификации
7	Температурный диапазон, при котором изделие надежно сохраняется	14	Дата производства

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Кабели пациента,
производитель
BioMed Devices,
США.

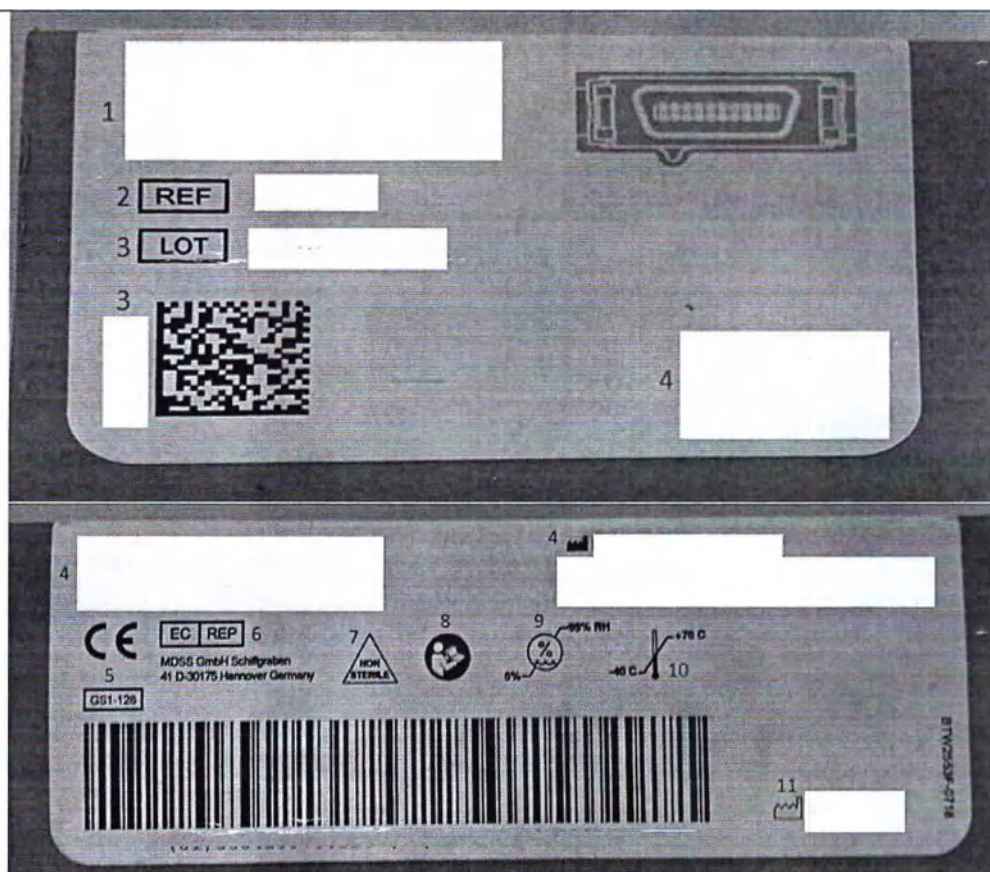

1	Наименование изделия	7	Не стерильно
2	Каталожный номер	8	Обратитесь к инструкции
3	Серийный номер	9	Диапазон влажности, при котором изделие надежно сохраняется
4	Наименование производителя и/или адрес производителя	10	Температурный диапазон, при котором изделие надежно сохраняется
5	Формат штрихкода	11	Дата производства
6	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе		

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Теплоотражающие
пластины для
датчиков,
производитель Vyairе
Medical INC, США.



1

2

REF

3




SN

4

5

1	Наименование производителя и/или адрес производителя
2	Наименование изделия
3	Каталожный номер
4	Серийный номер
5	Страна производства

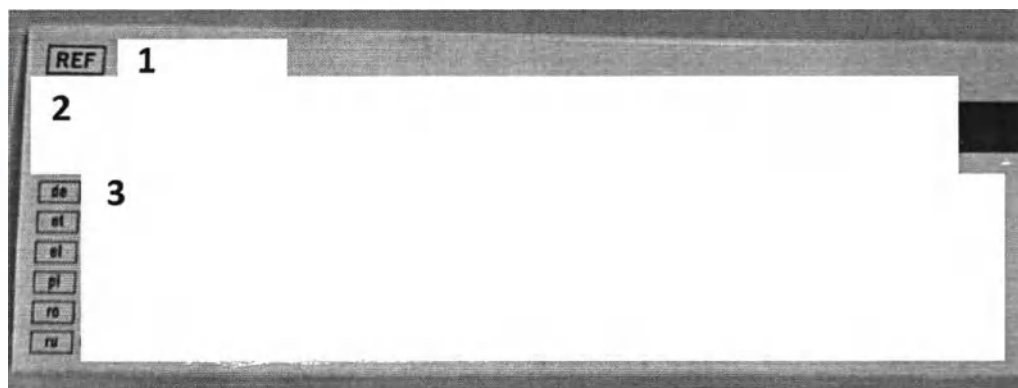


1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Наименование изделия на различных языках

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Шланги для
кислорода,
производитель Ohio
Medical Corporation,
США.

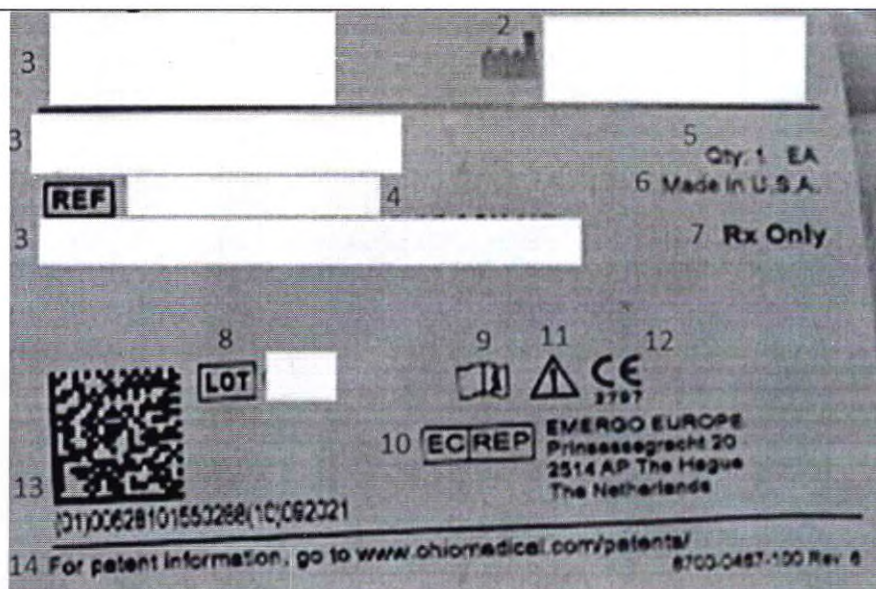

1	Наименование и логотип компании	8	Код партии
2	Наименование производителя и/или адрес производителя	9	Обратитесь к инструкции по применению
3	Наименование изделия	10	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
4	Каталожный номер	11	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
5	1 штука в каждой упаковке	12	Знак CE и код органа сертификации
6	Сделано в США	13	Уникальный идентификатор (UDI)
7	Только для США. Наклейка с требованием продажи только по предписанию врача	14	Для получения информации о патенте, перейдите на сайт www.ohiomedical.com/patent

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Шланги для воздуха,
производитель Ohio
Medical Corporation,
США.



1	Наименование и логотип компании	8	Код партии
2	Наименование производителя и/или адрес производителя	9	Обратитесь к инструкции по применению
3	Наименование изделия	10	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
4	Каталожный номер	11	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
5	1 штука в каждой упаковке	12	Знак CE и код органа сертификации
6	Сделано в США	13	Уникальный идентификатор (UDI)
7	Только для США. Наклейка с требованием продажи только по предписанию врача	14	Для получения информации о патенте, перейдите на сайт www.ohiomedical.com/patent

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Емкости для
аспиратора,
производитель Bemis
Healthcare, США.



1	Наименование производителя и/или адрес производителя	8	Осторожно!Обратитесь к инструкции по применению
2	Знак CE	9	Медицинское изделие
3	Каталожный номер	10	Обратитесь к инструкции по применению
4	Количество штук в упаковке	11	Не стерильно
5	Номер партии	12	Не подлежит повторному использованию
6	Использовать до	13	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
7	Наименование изделия на разных языках		

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Реанимационные
блоки, производитель
GE Healthcare, США.



1	Каталожный номер
2	Конфигурация
3	Серийный номер

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация


Маски дыхательные,
производитель
Flexicare Medical
Limited

1	Каталожный номер
2	Наименование изделия
3	Серийный номер
4	Наименование производителя и/или адрес производителя
5	Страна производства

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация

Корзина для принадлежностей

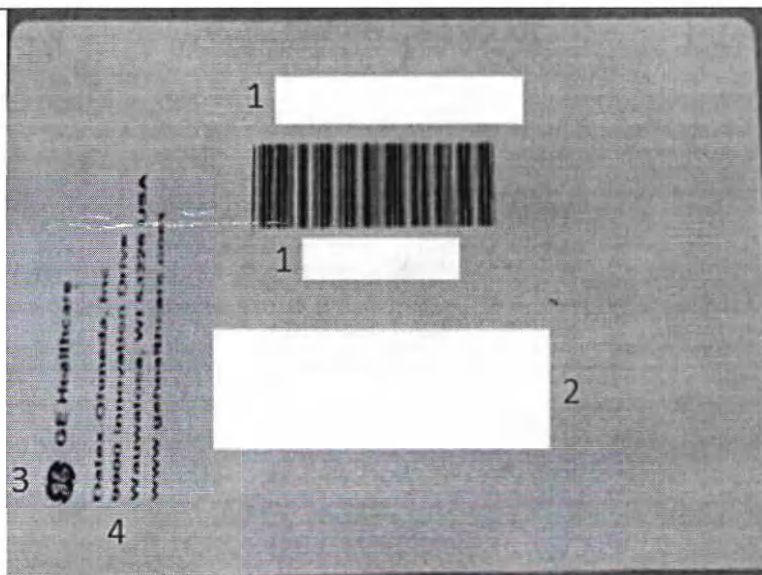


1	Каталожный номер	3	Наименование и логотип компании
2	Наименование изделия	4	Наименование производителя и/или адрес производителя

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Кронштейны мониторов

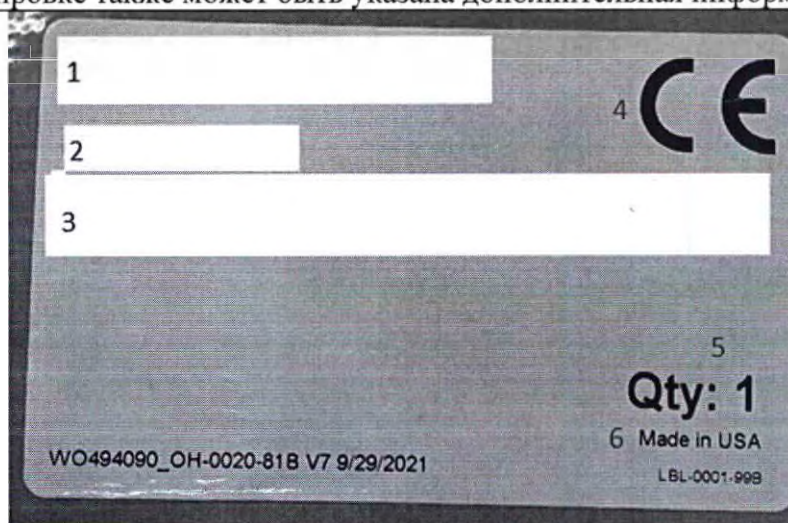

1	Каталожный номер	4	Знак CE
2	Серийный номер	5	Количество: 1
3	Наименование изделия	6	Сделано в США

Примечание:

На маркировке также может быть указана дополнительная информация.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 21 лист(ов)
Директор департамента Регистрации
и Сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
Харитонов А.П.



Handwritten signature in blue ink.





Фотографические изображения медицинского изделия

Комплекс реанимационный открытый Giraffe Warmer с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
Регистрации и сертификации, Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»




А.П. Харитонов

«27» декабря 2022 г.


Комплекс реанимационный открытый Giraffe Warmer



Устройство управления с дисплеем, панелью управления

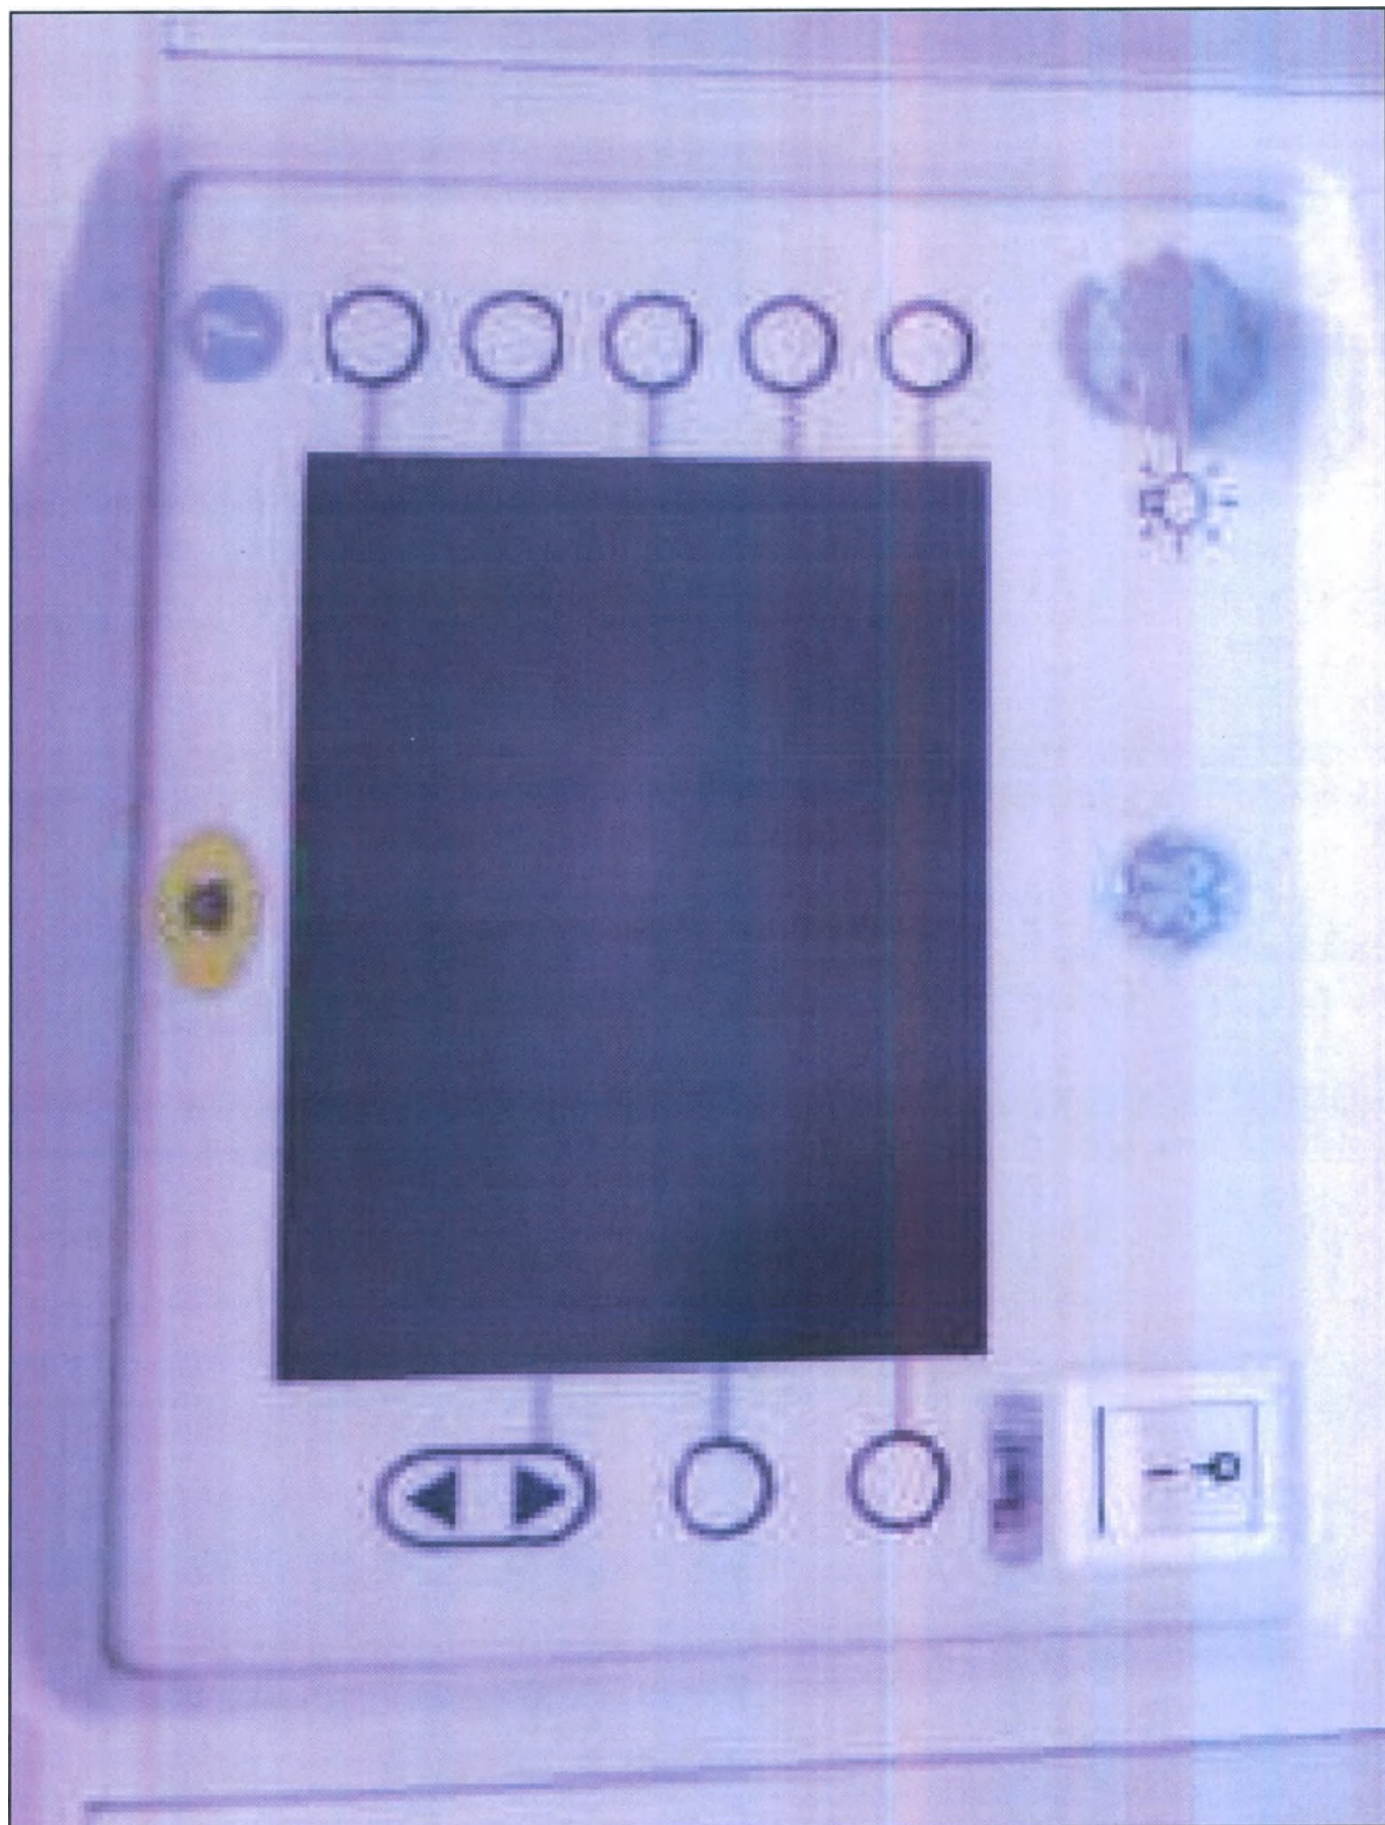

Нагревательный элемент с кабелем подключения

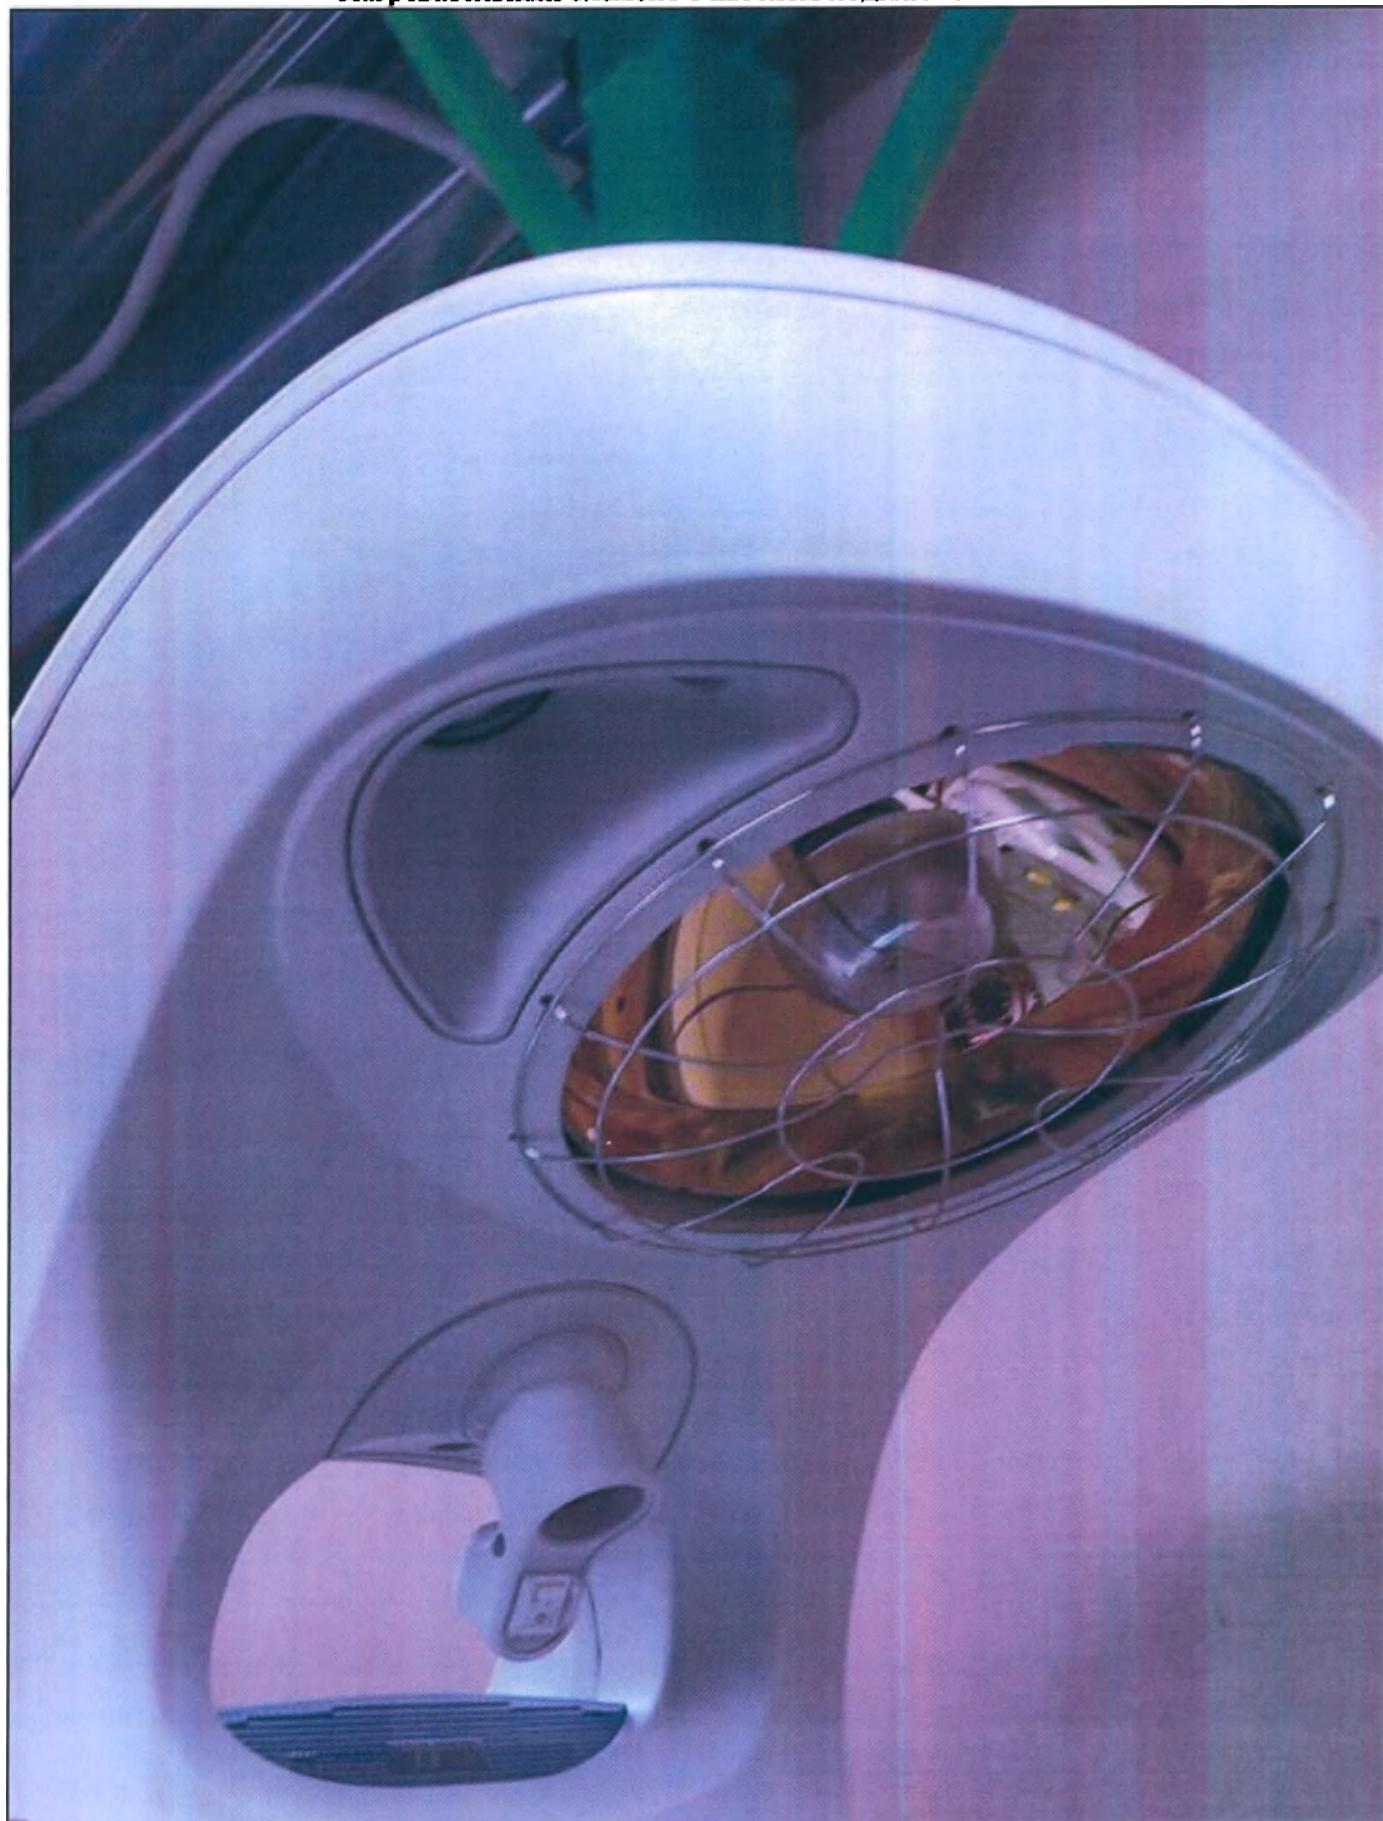



Предупреждение:
Не помещайте предметы
на верхнюю поверхность
нагревательной головки.




Предупреждение:
Не подвешивайте
предметы на головке
излучателя.



M1110855 Rev A Russian ©

Панель для ложа пациента



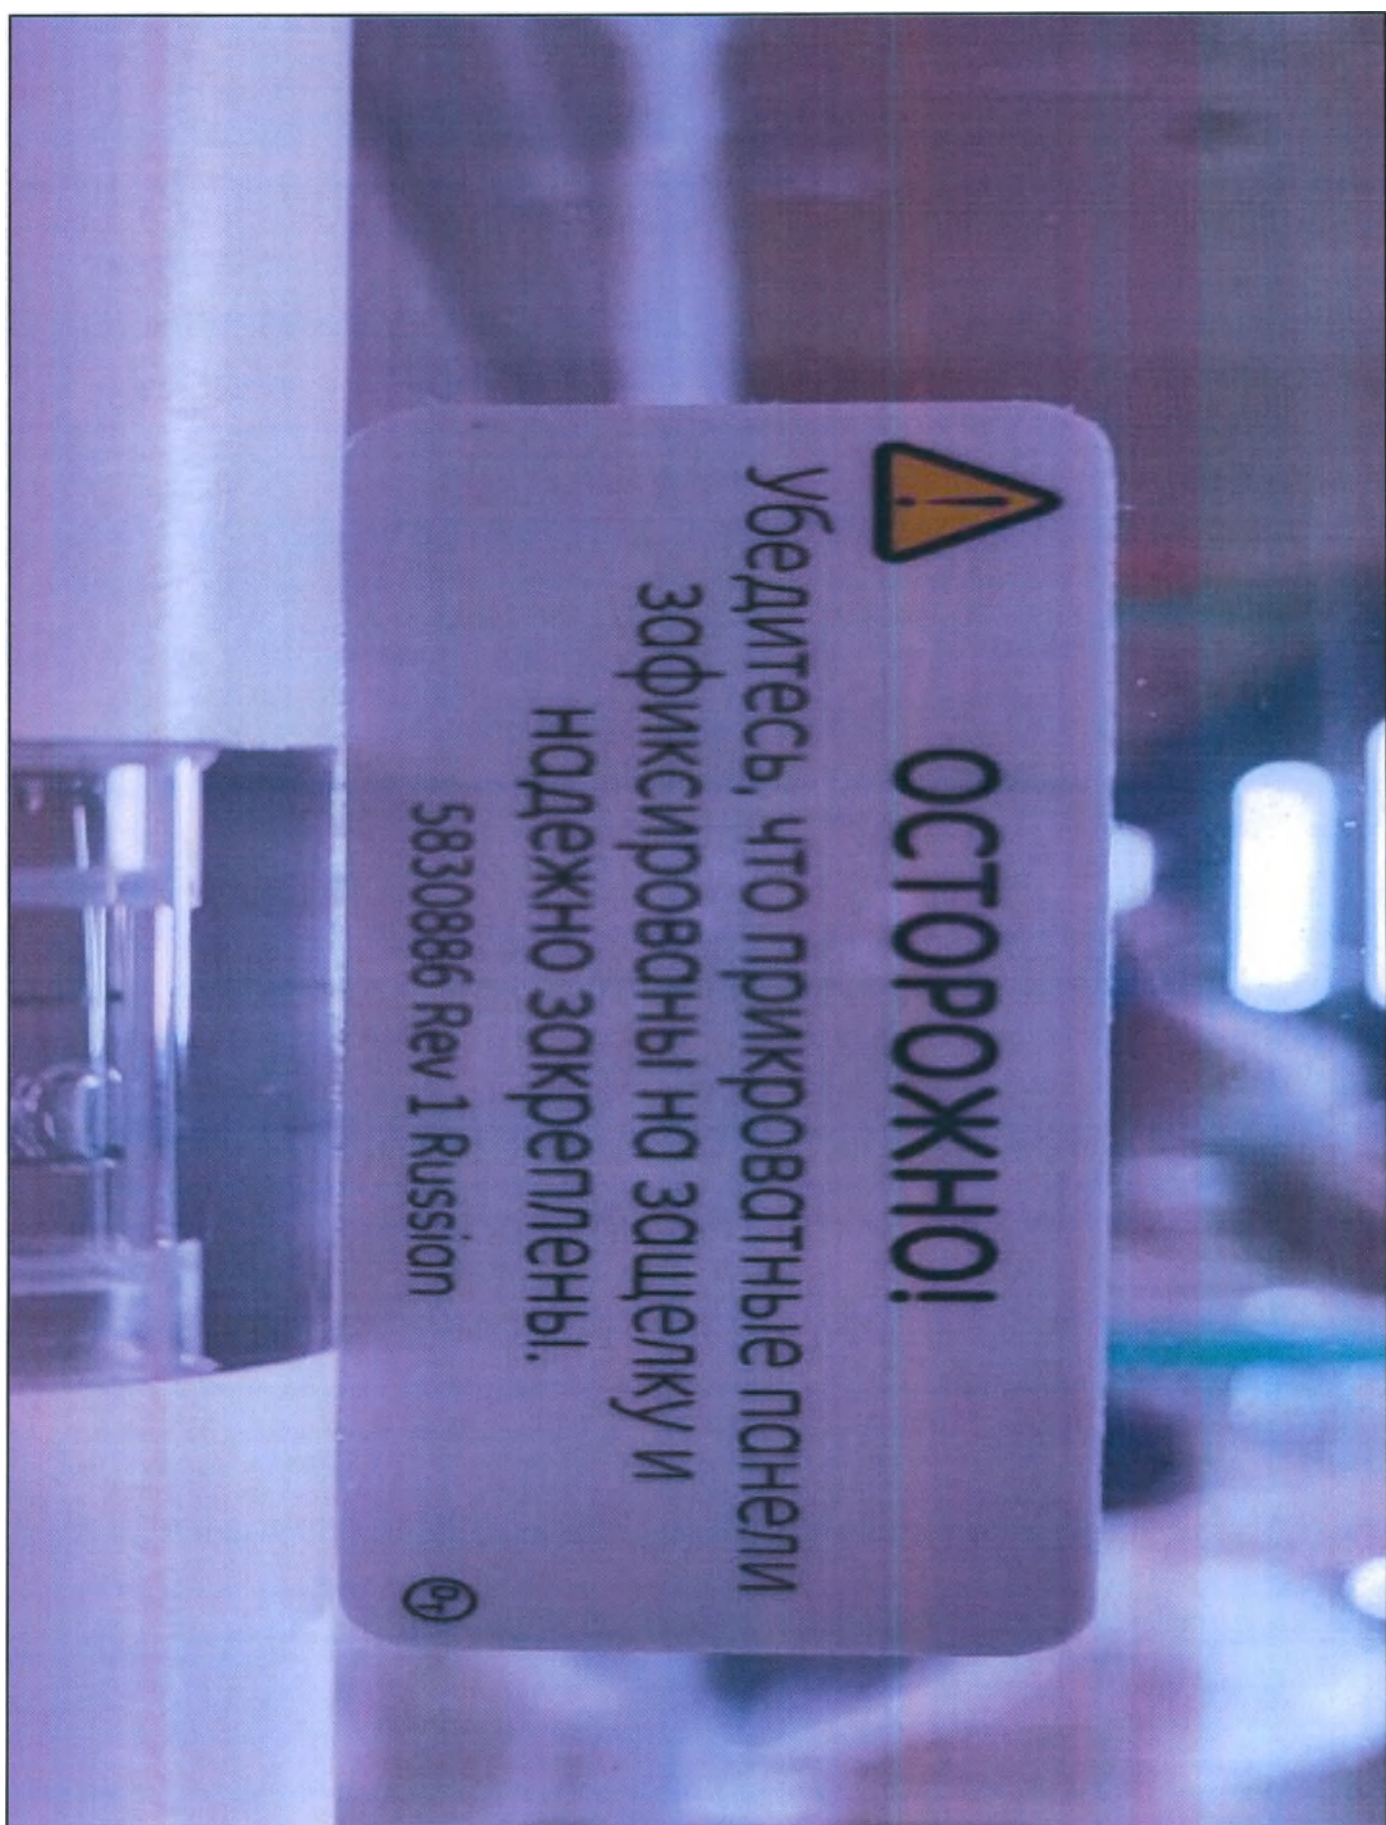

Рельсы для крепления дополнительного медицинского оборудования




Комплекс реанимационный открытый Giraffe Warmer


Руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию




Кабель питания

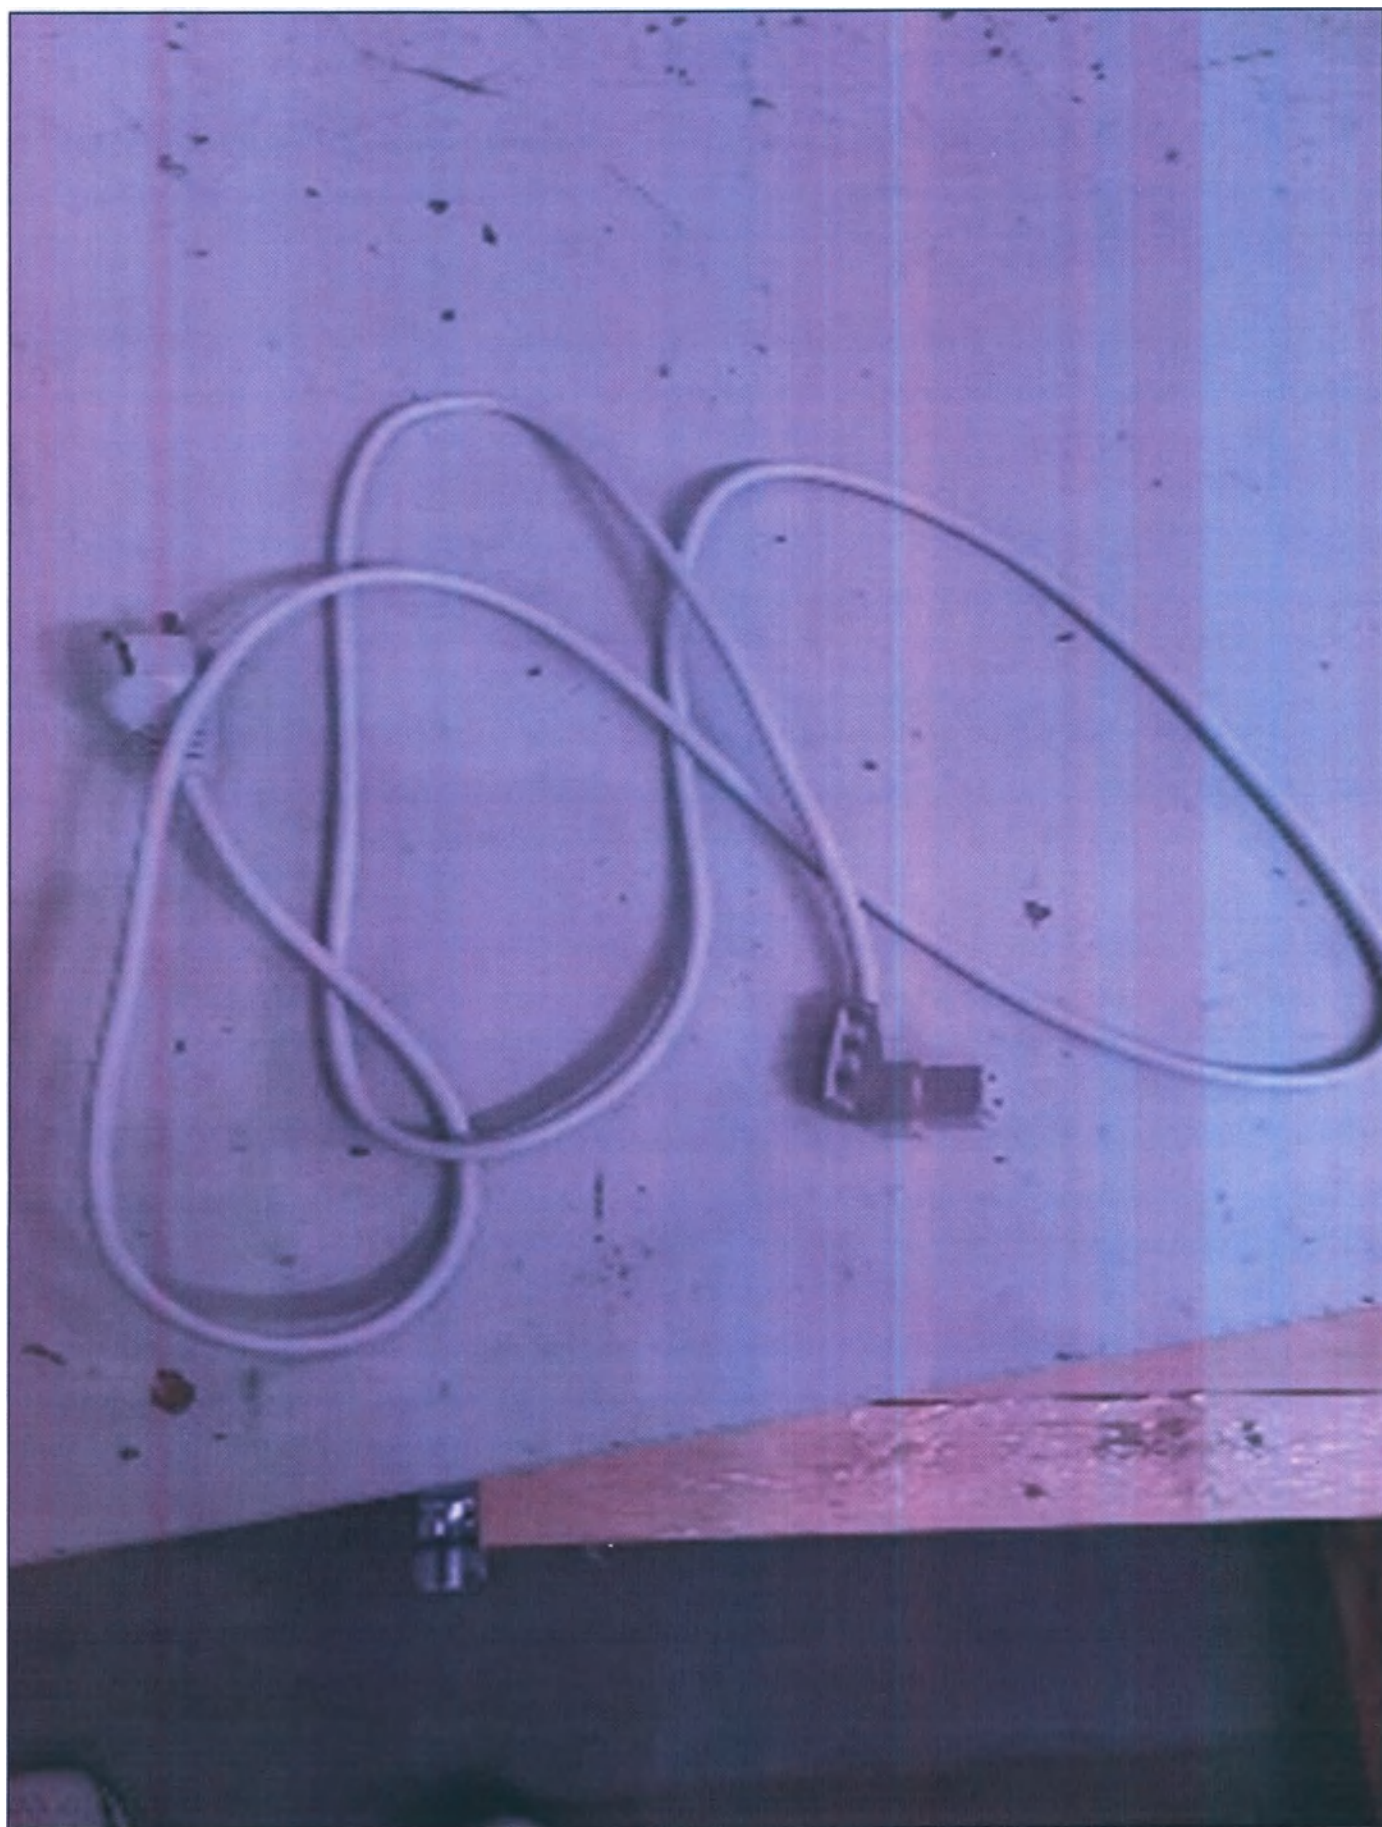


Датчики температурные многоразовые, производитель CareFusion Finland 320
ОУ, Финляндия

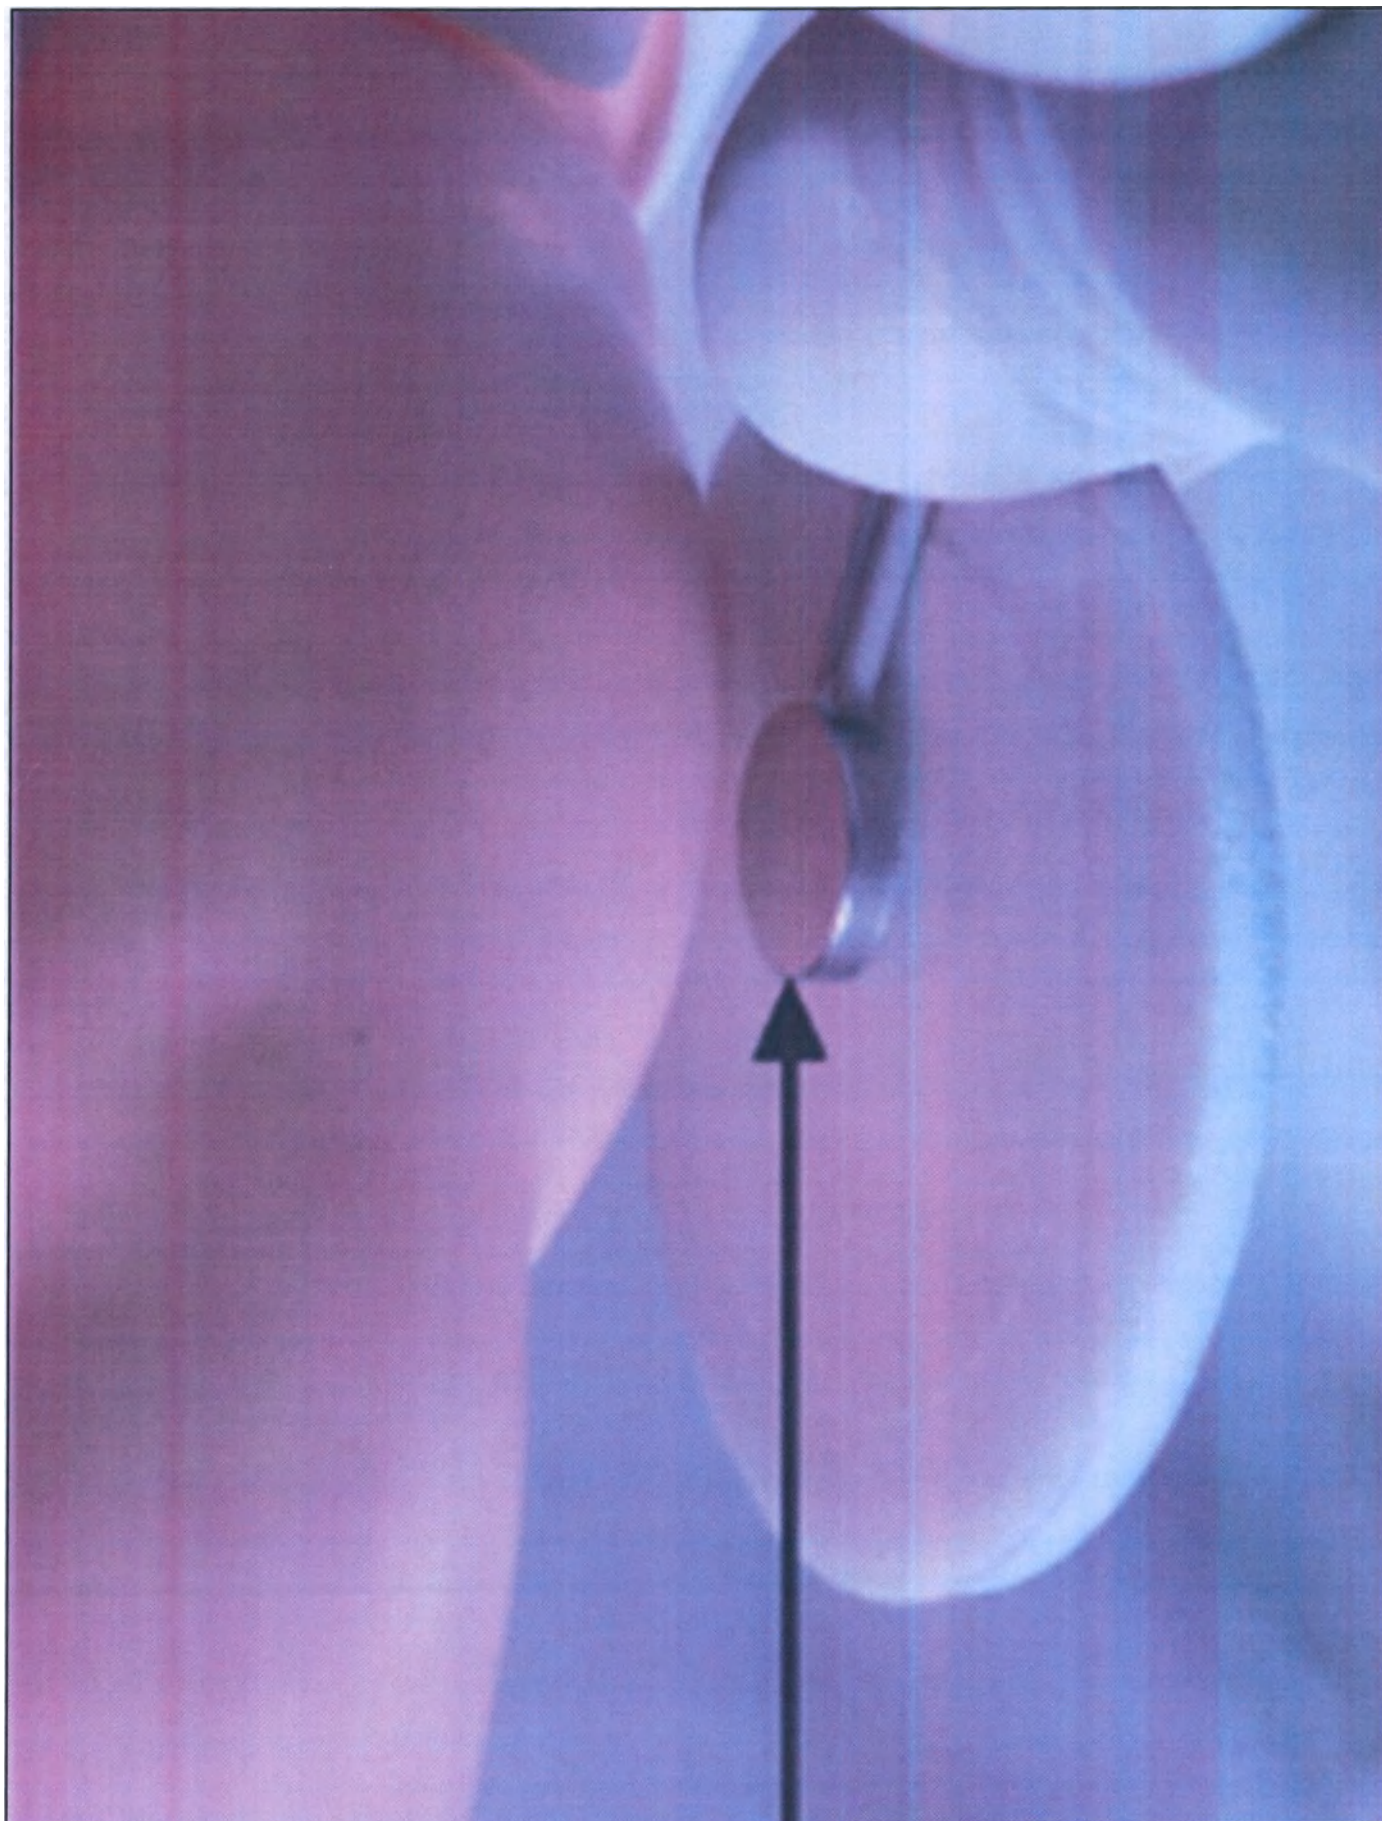

**Датчики температурные многоразовые, производитель CareFusion Finland 320 OY,
Финляндия**

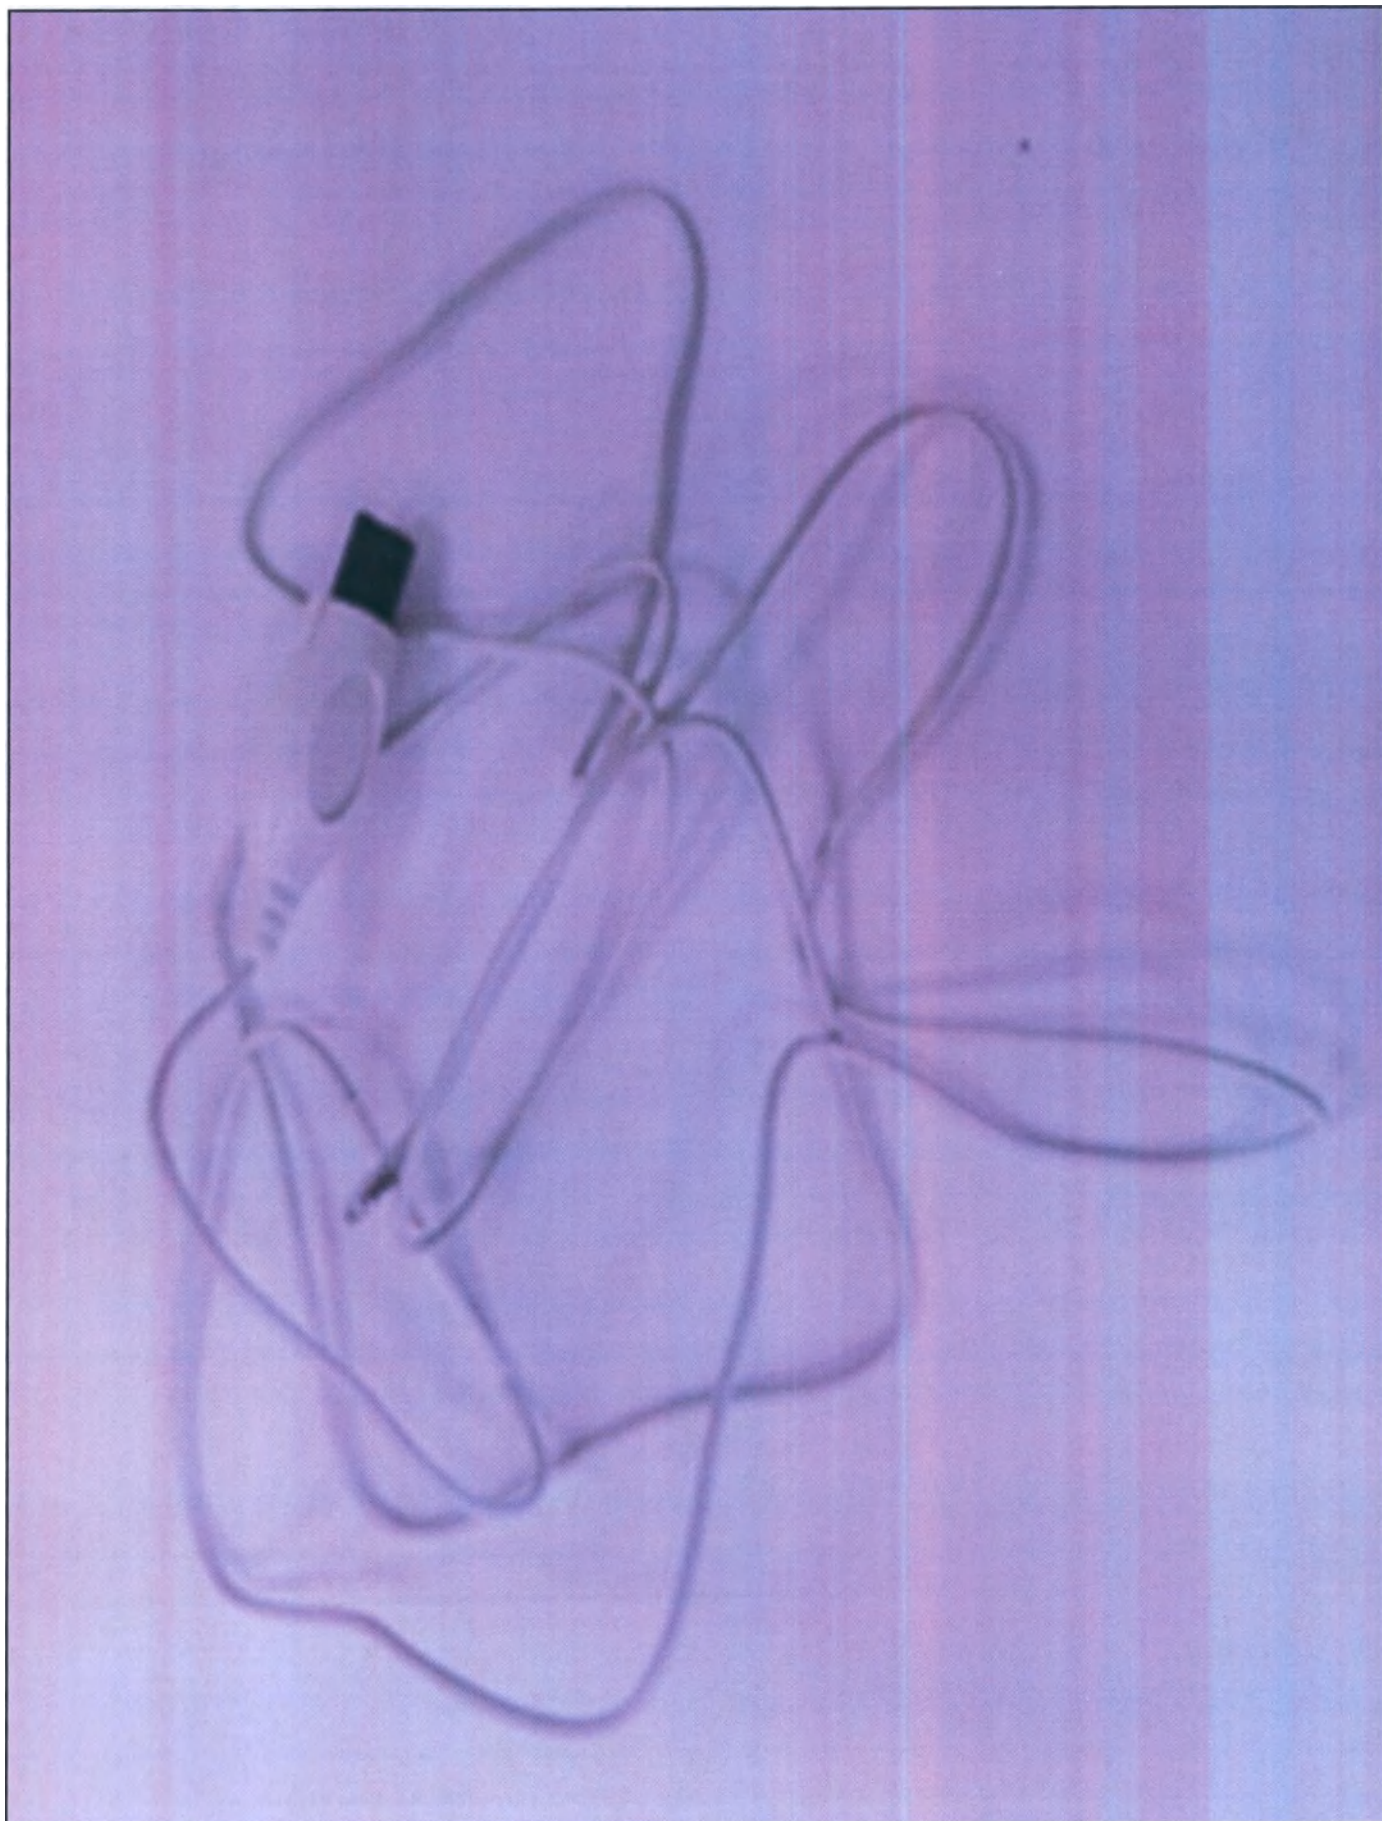


Датчики температурные многоразовые, производитель CareFusion Finland 320
ОУ, Финляндия

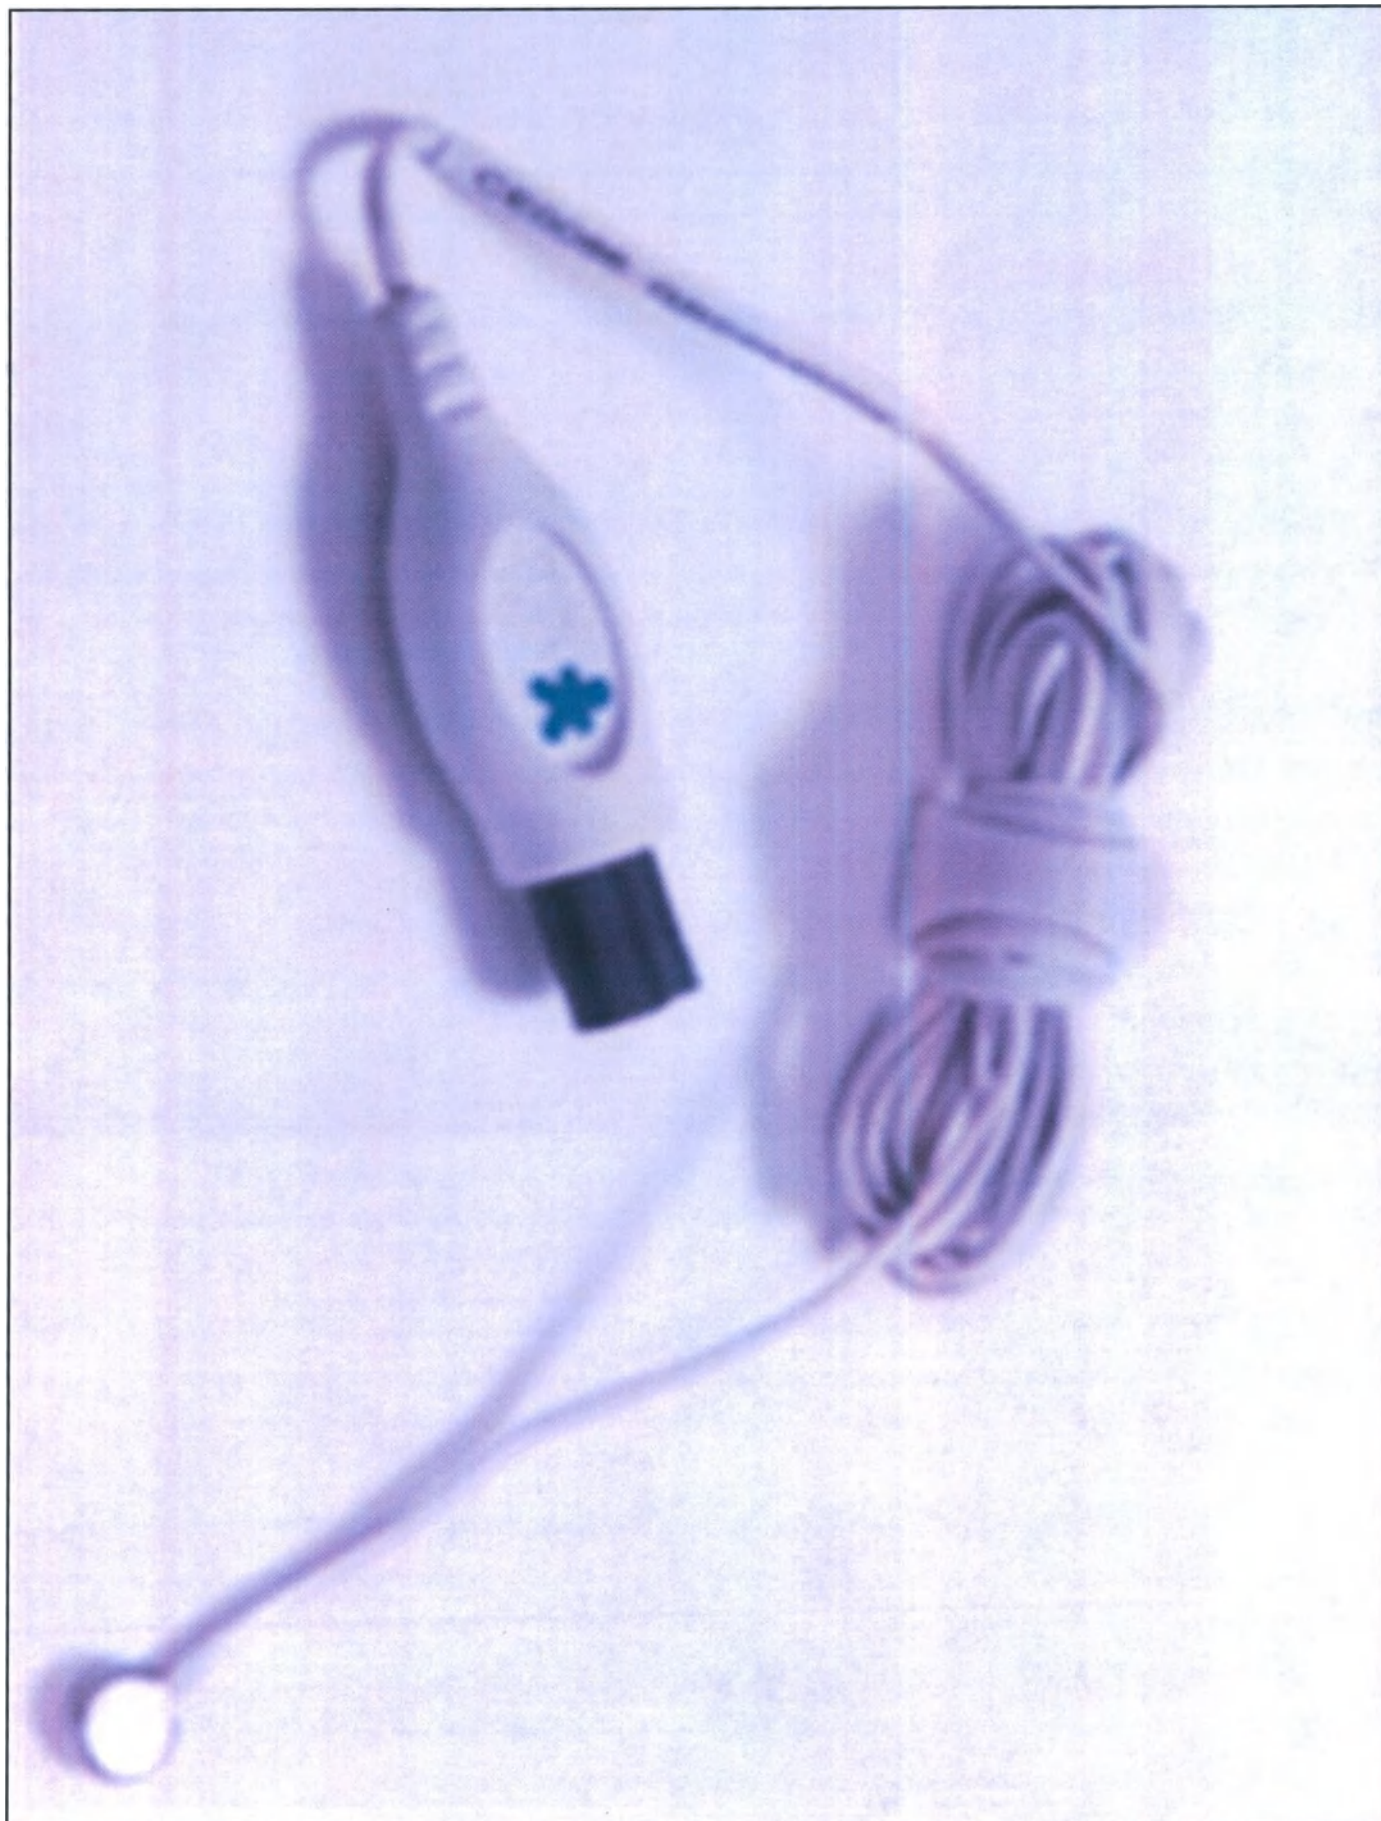

Датчики температурные одноразовые, производитель Vyair Medical INC, США




Датчики пульсоксиметрические многоцветные, производитель Masimo CORP, США

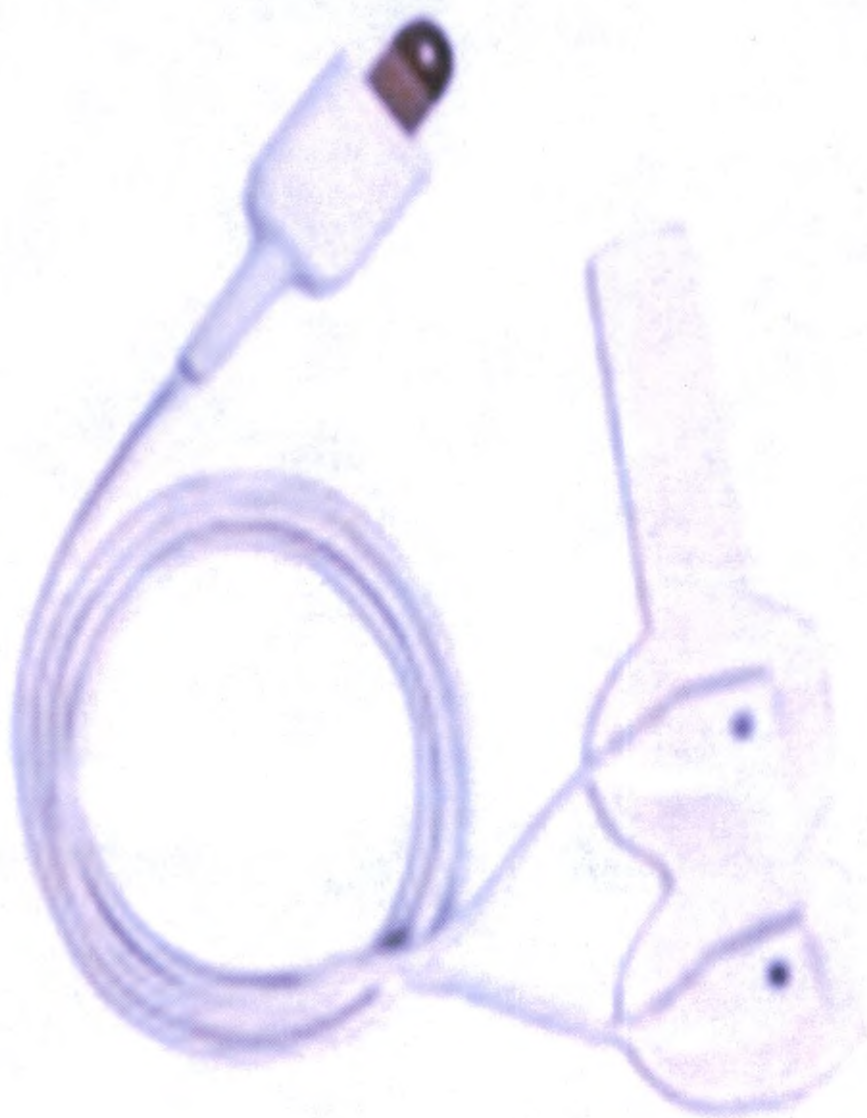

Датчики пульсоксиметрические одноразовые, производитель Masimo CORP, США



Датчики пульсоксиметрические одноразовые, производитель Masimo CORP, США

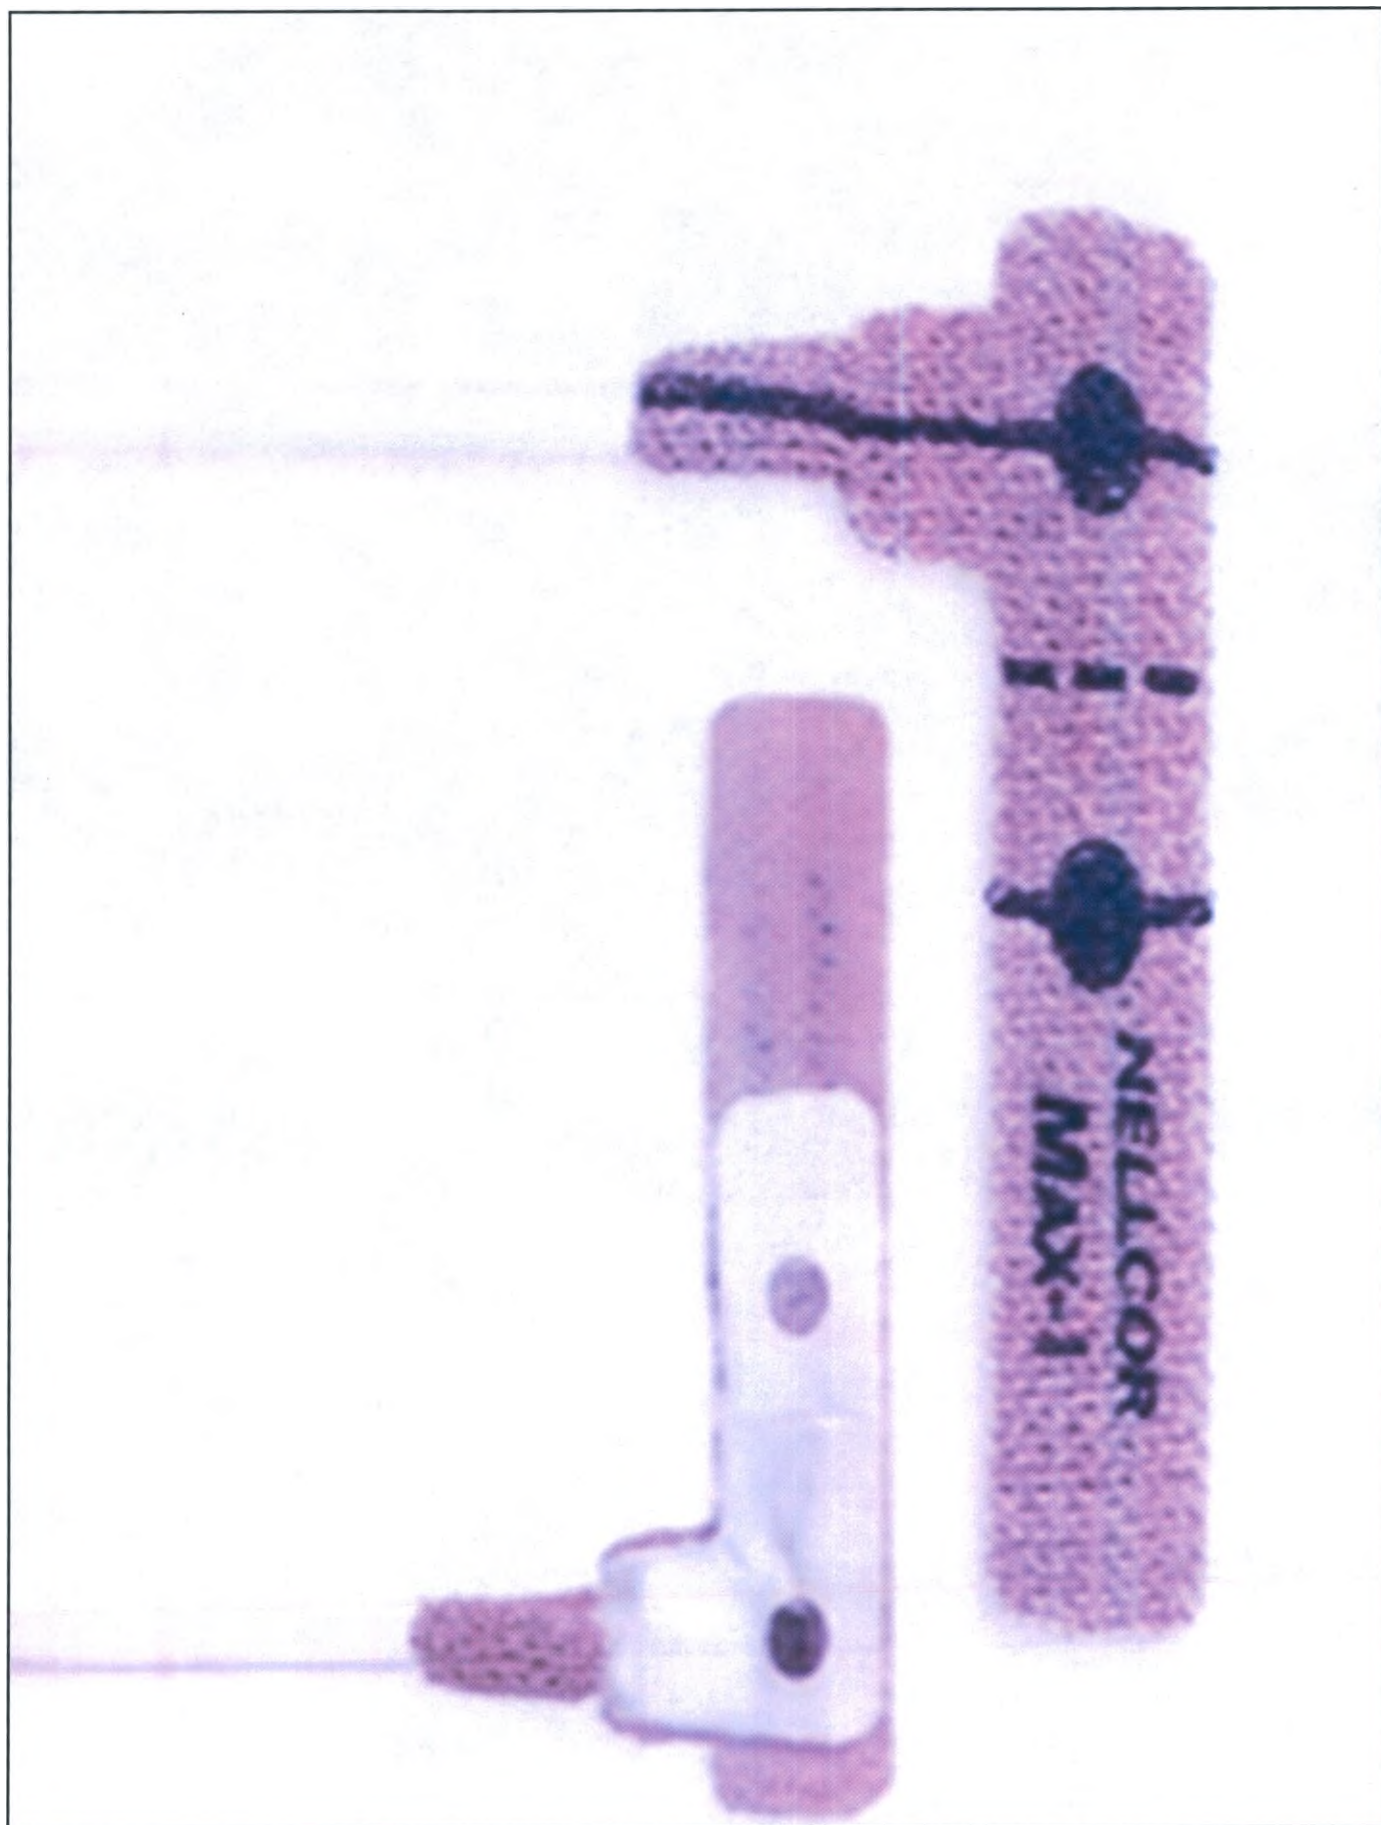

Датчики пульсоксиметрические одноразовые, производитель Masimo CORP, США




Датчики пульсоксиметрические одноразовые, производитель Masimo CORP, США



Датчики пульсоксиметрические одноразовые, производитель Masimo CORP, США



Датчики пульсоксиметрические одноразовые, производитель Masimo CORP, США

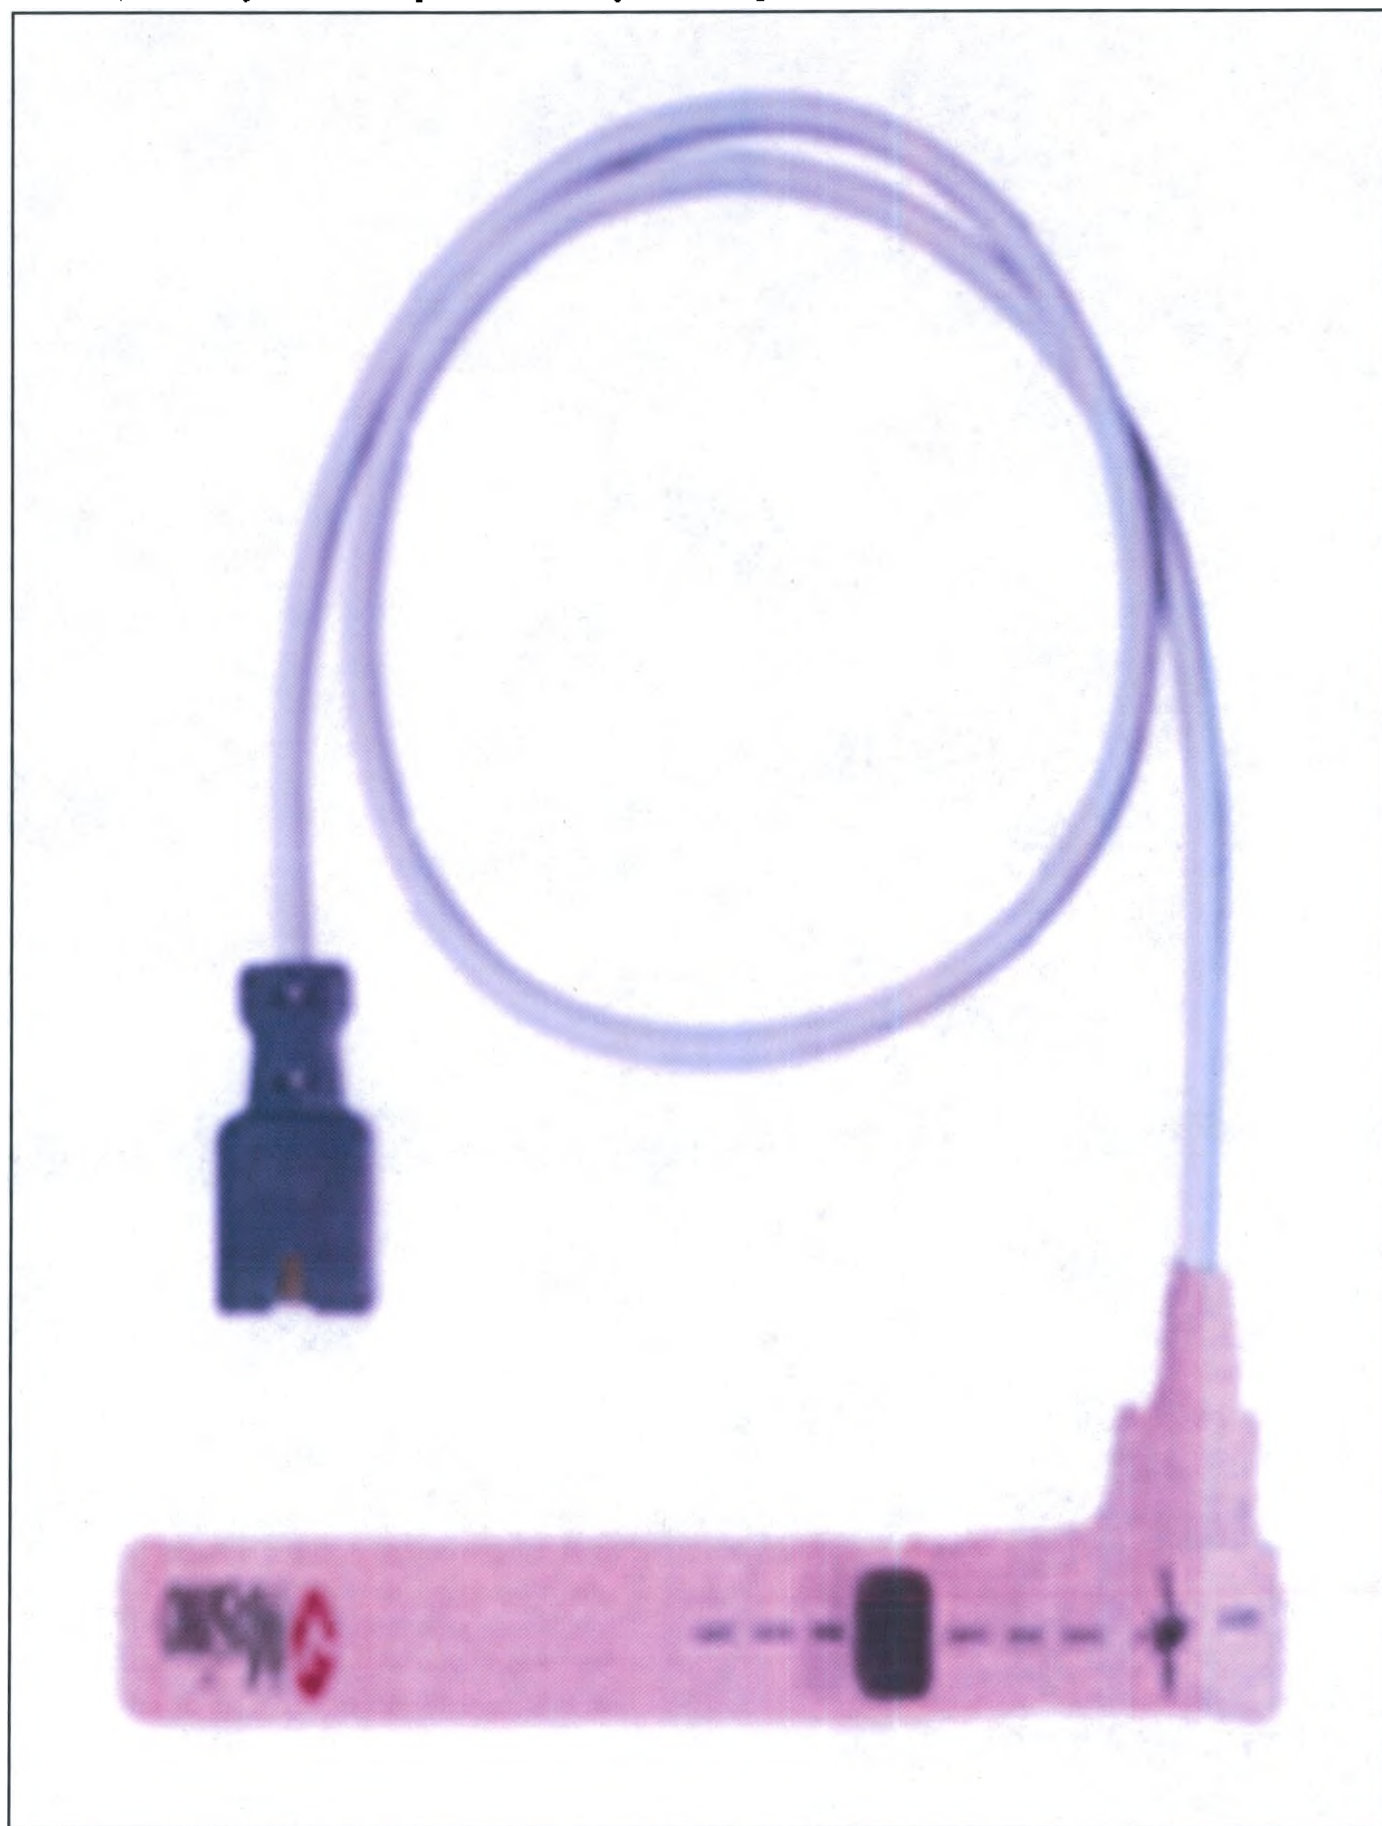

Лампы фототерапии со световодом, производитель Lumitex, США



Лампы фототерапии со световодом, производитель Lumitex, США




Электронные весы, производитель Datex-Ohmeda Inc., США



Инфузионные стойки, производитель GE Healthcare, США



Контуры пациента, производитель Flexicare Medical Limited, США

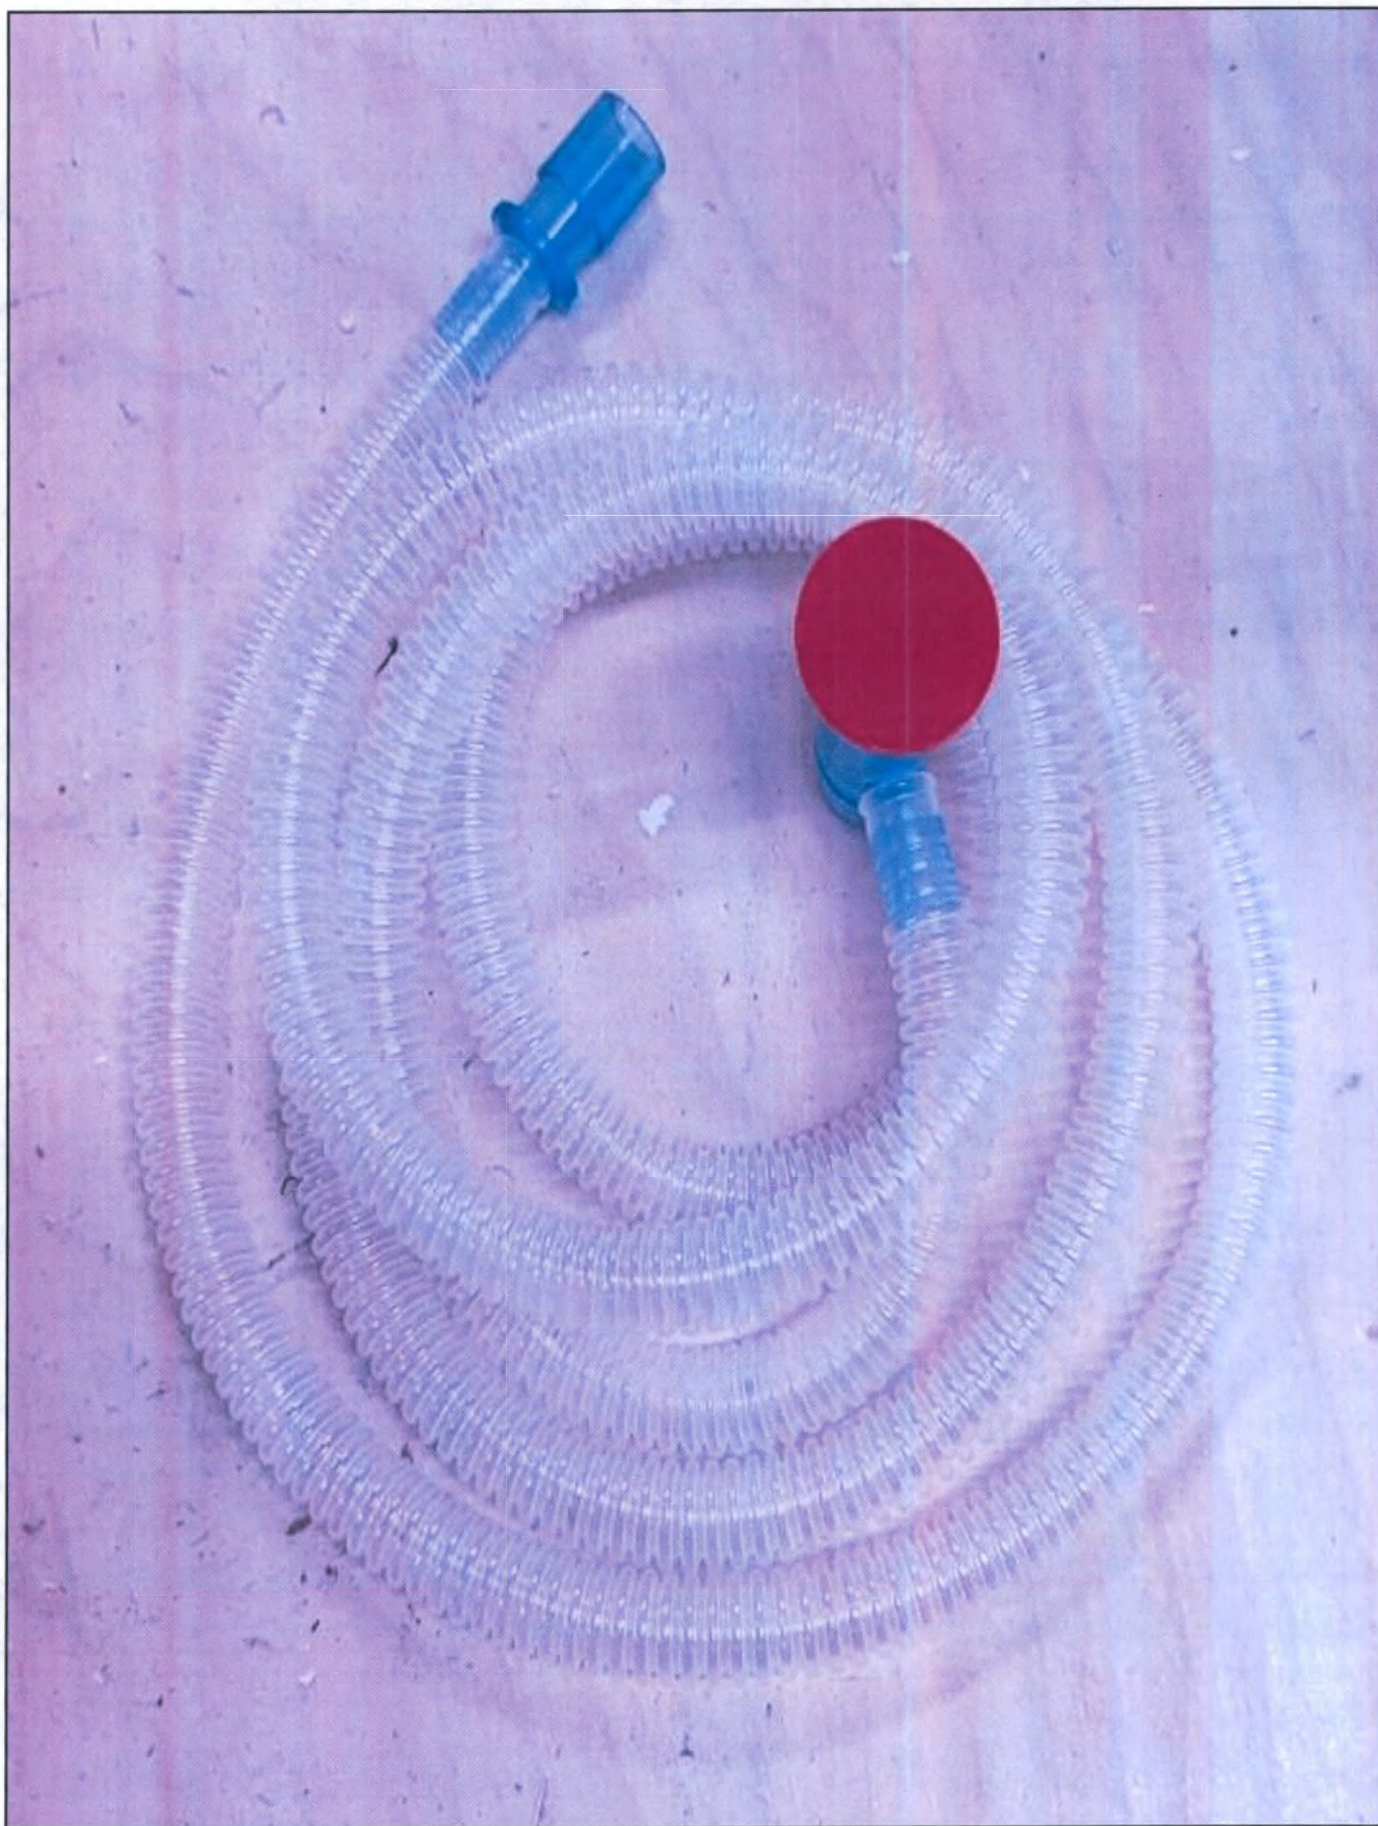


Маски дыхательные, производитель Flexicare Medical Limited, США



Флоуметры (для подачи кислорода), производитель GE Healthcare, США



Пульсоксиметрический модуль Massimo, производитель GE Healthcare, США

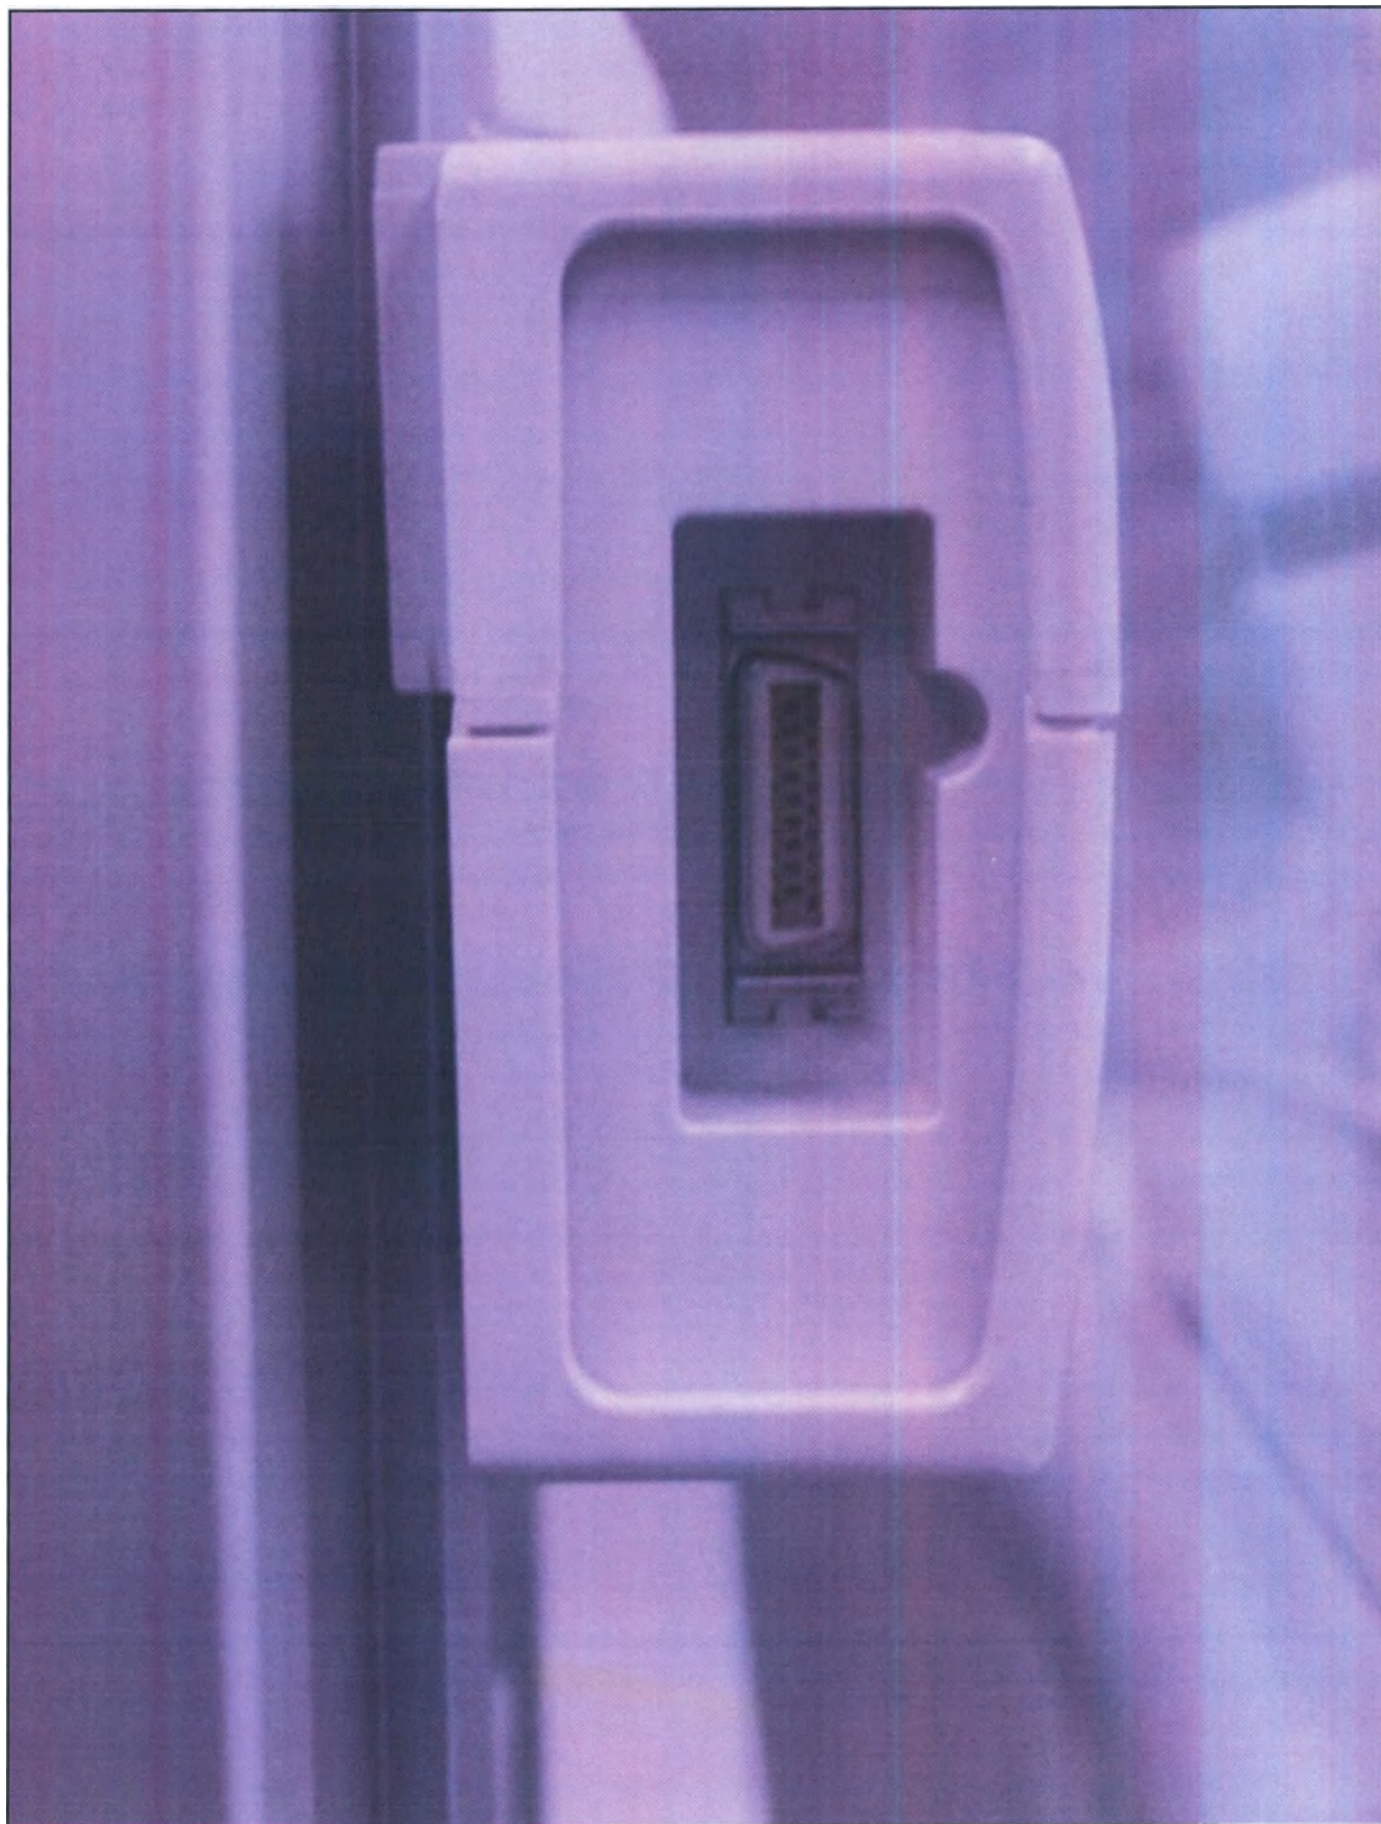


Пульсоксиметрический модуль Massimo, производитель GE Healthcare, США



Пульсоксиметрический модуль Nellcor, производитель GE Healthcare, США




Панель для подключения: датчиков, весов, смесителей, манометров, регуляторов давления

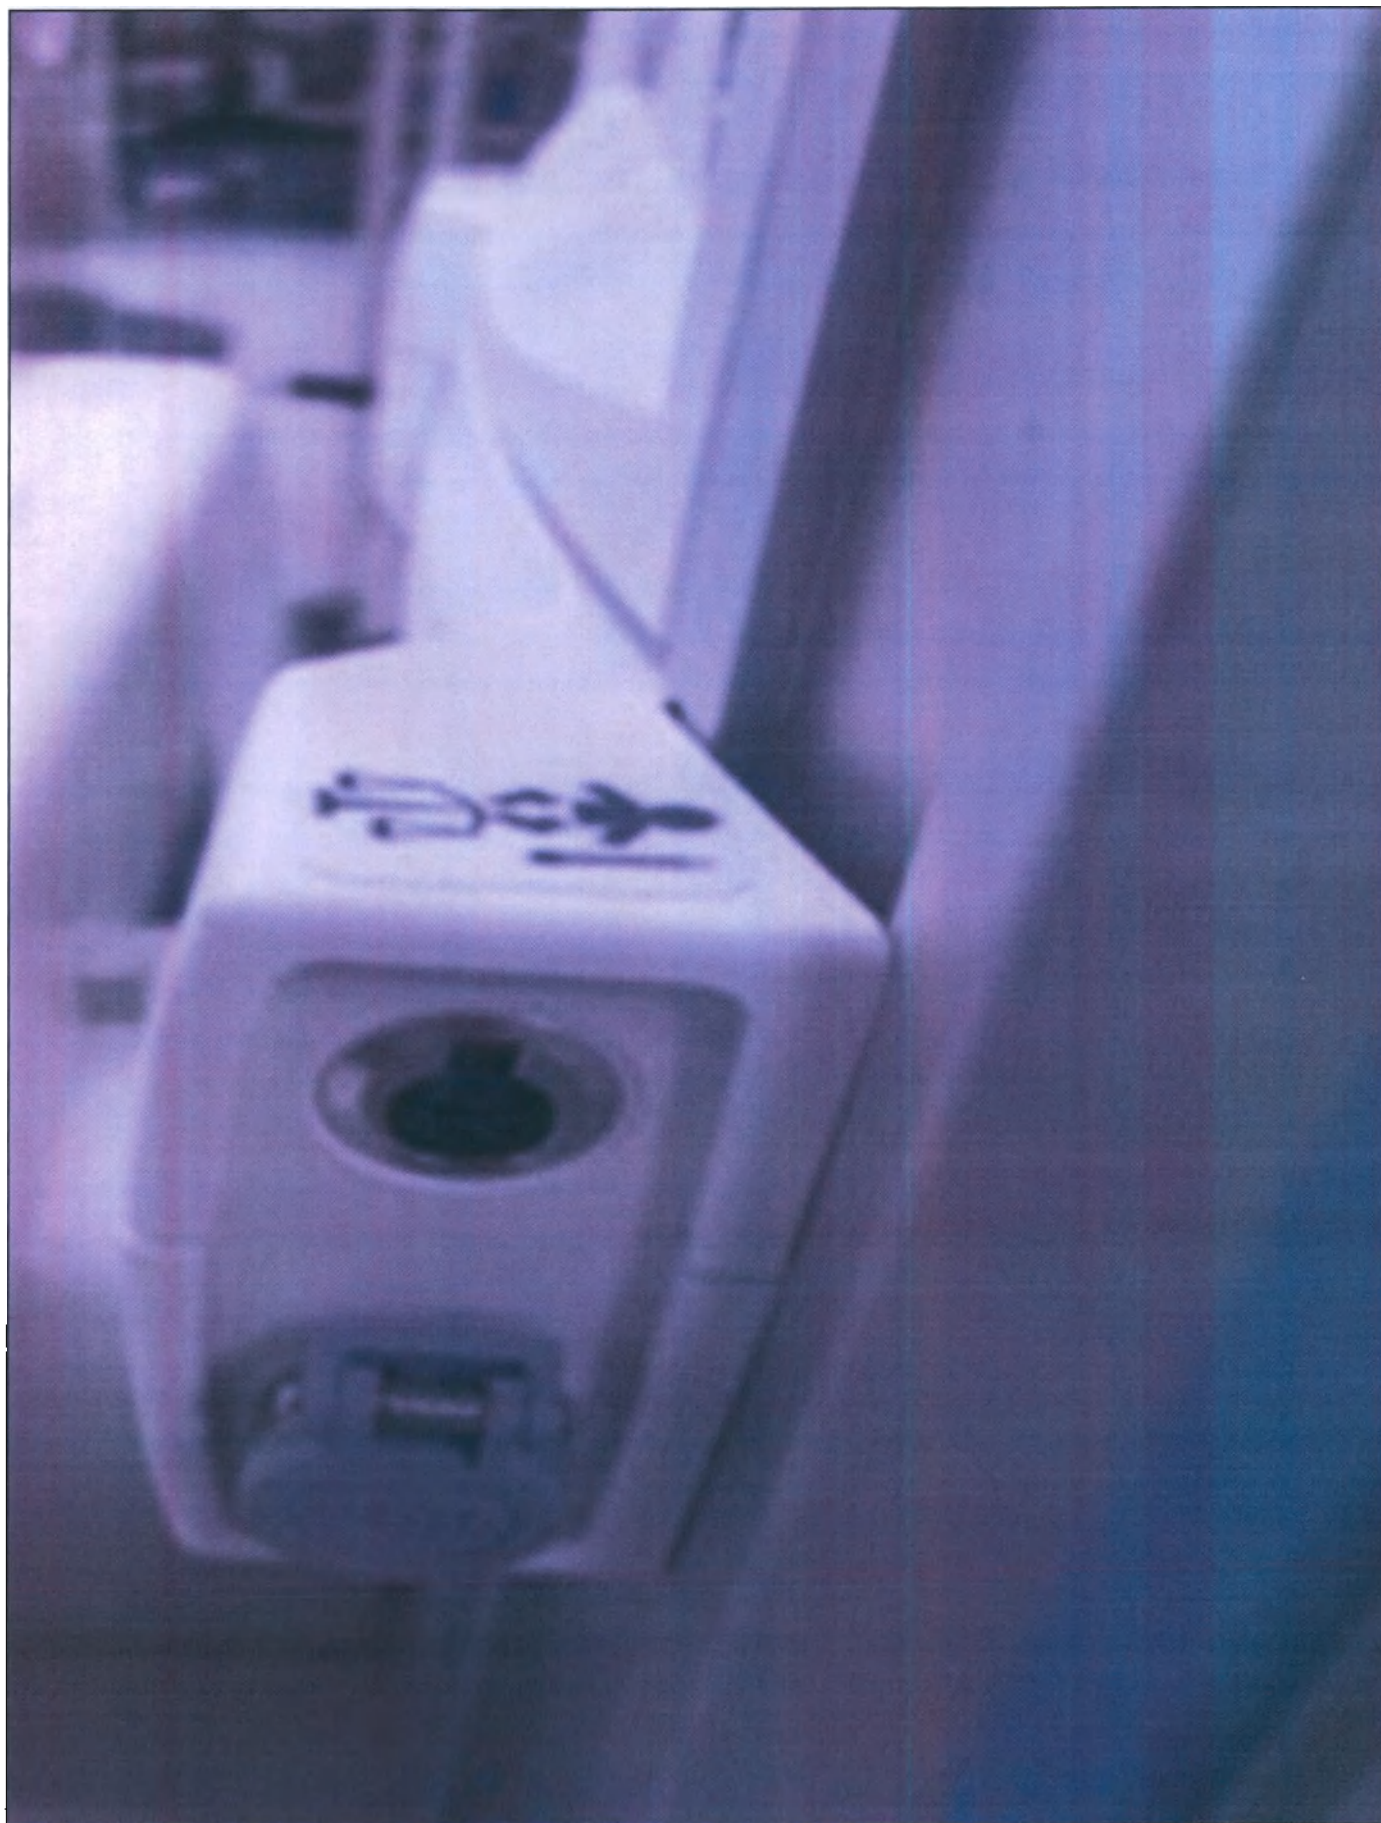


Панель для подключения: датчиков, весов, смесителей, манометров, регуляторов давления



Держатели, зажимы и крепежи для трубок, газовых баллонов, приборов – держатель

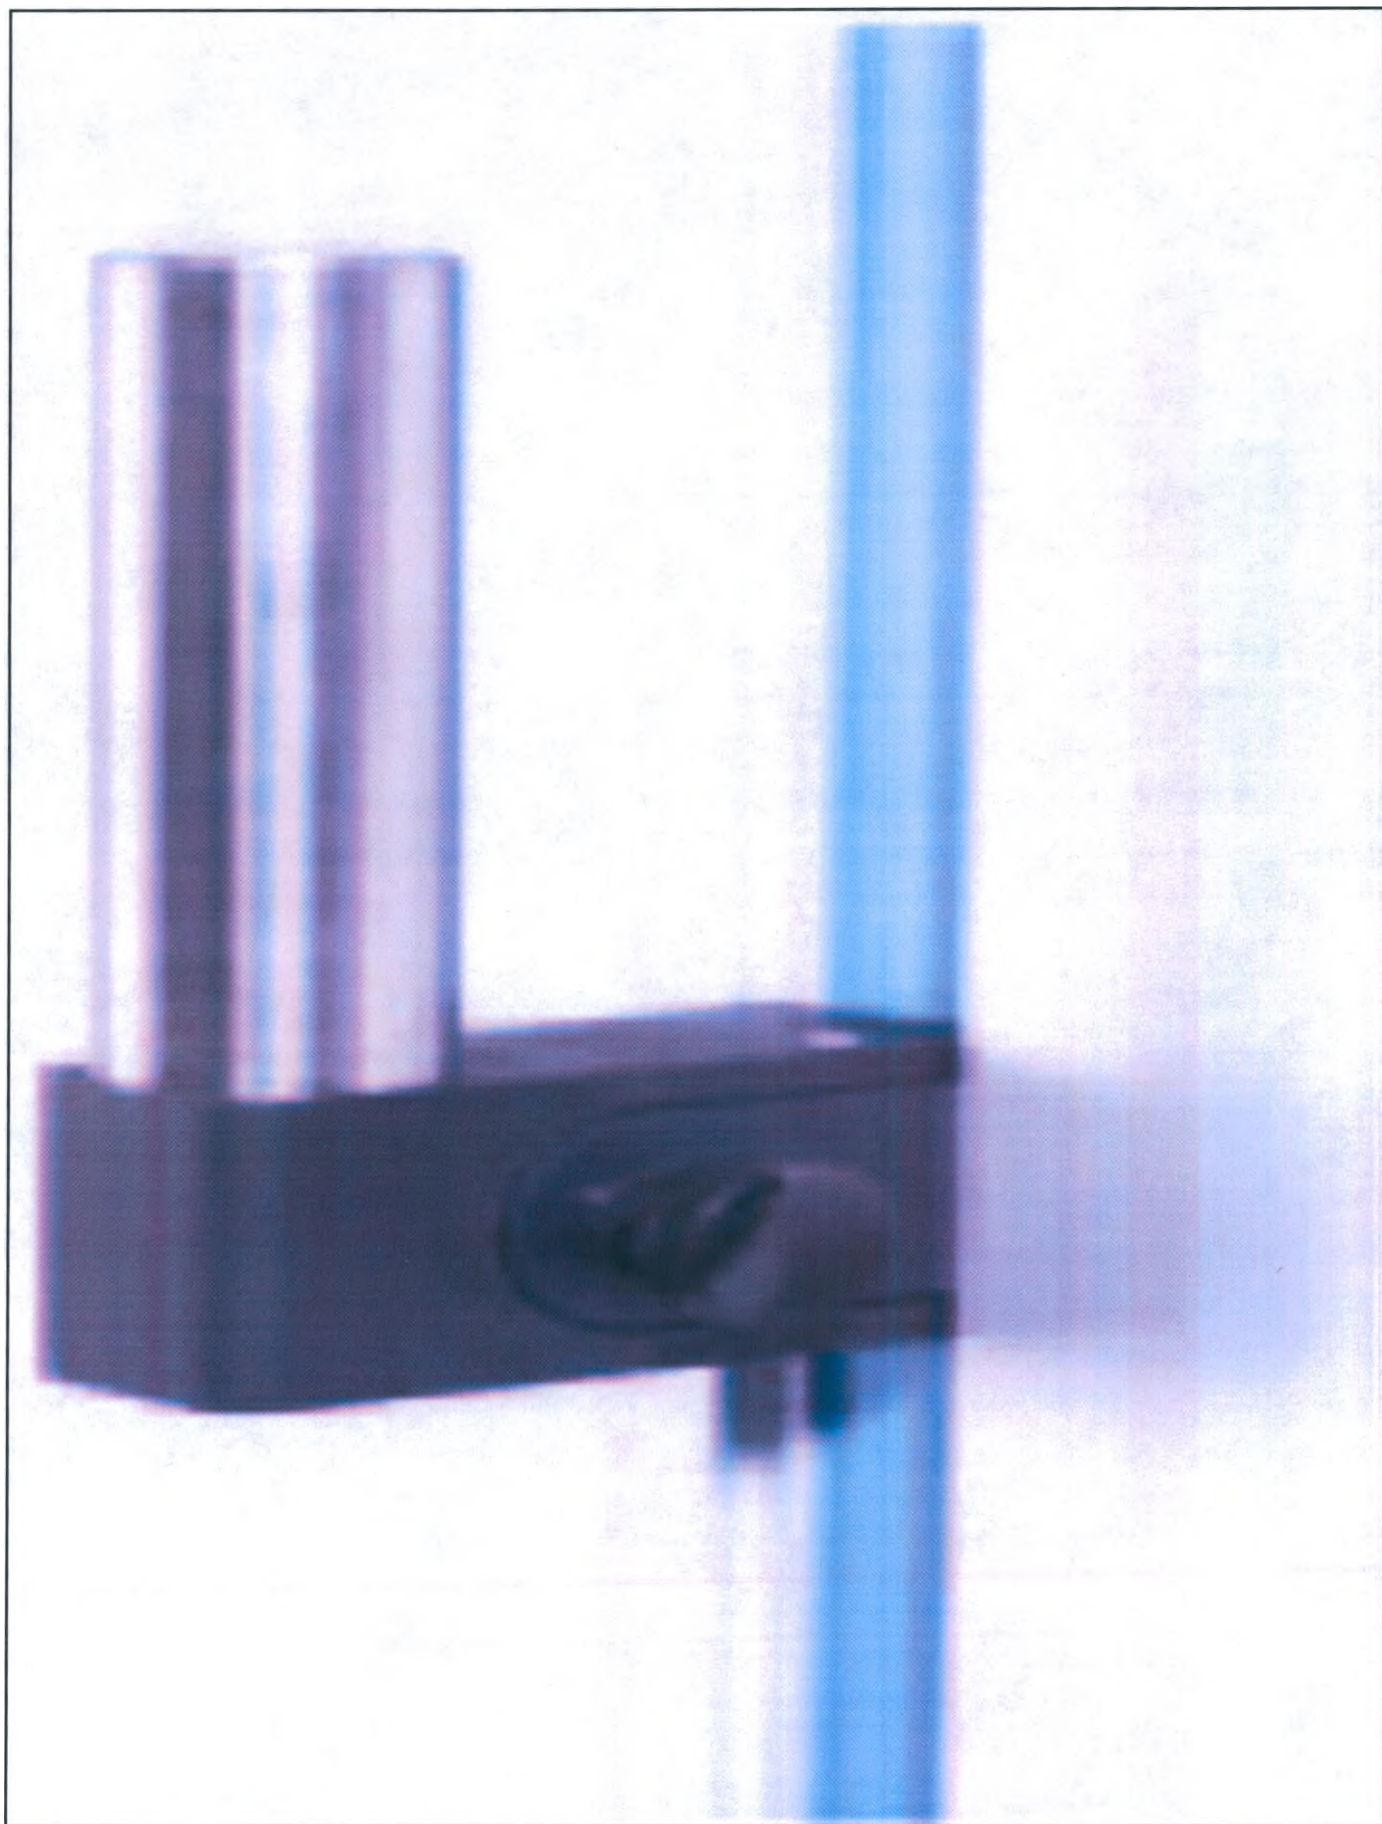


Держатели, зажимы и крепежи для трубок, газовых баллонов, приборов – держатель

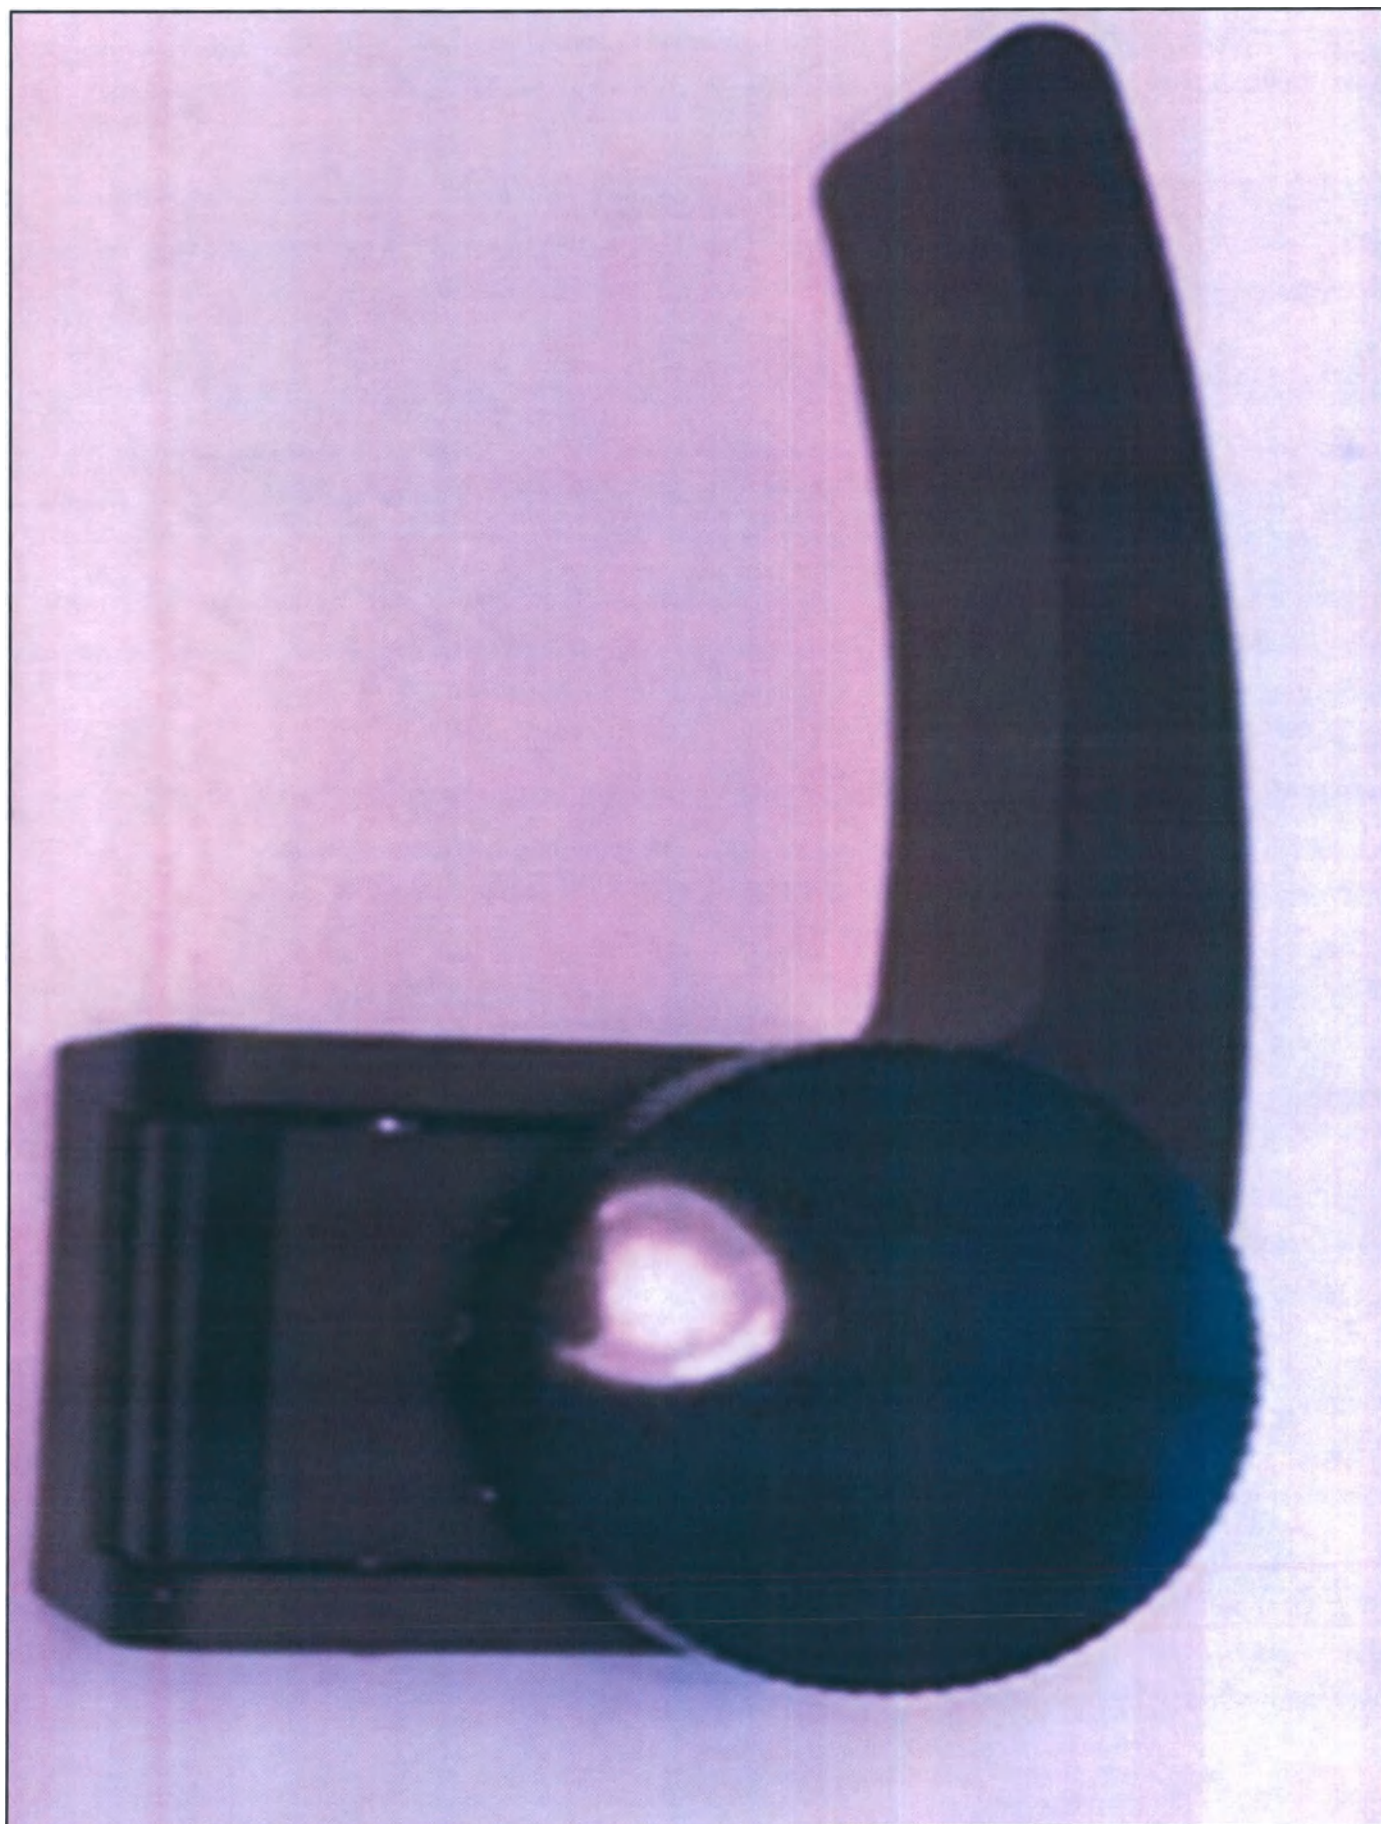

Держатели, зажимы и крепежи для трубок, газовых баллонов, приборов – держатель



Держатели, зажимы и крепежи для трубок, газовых баллонов, приборов - зажимы

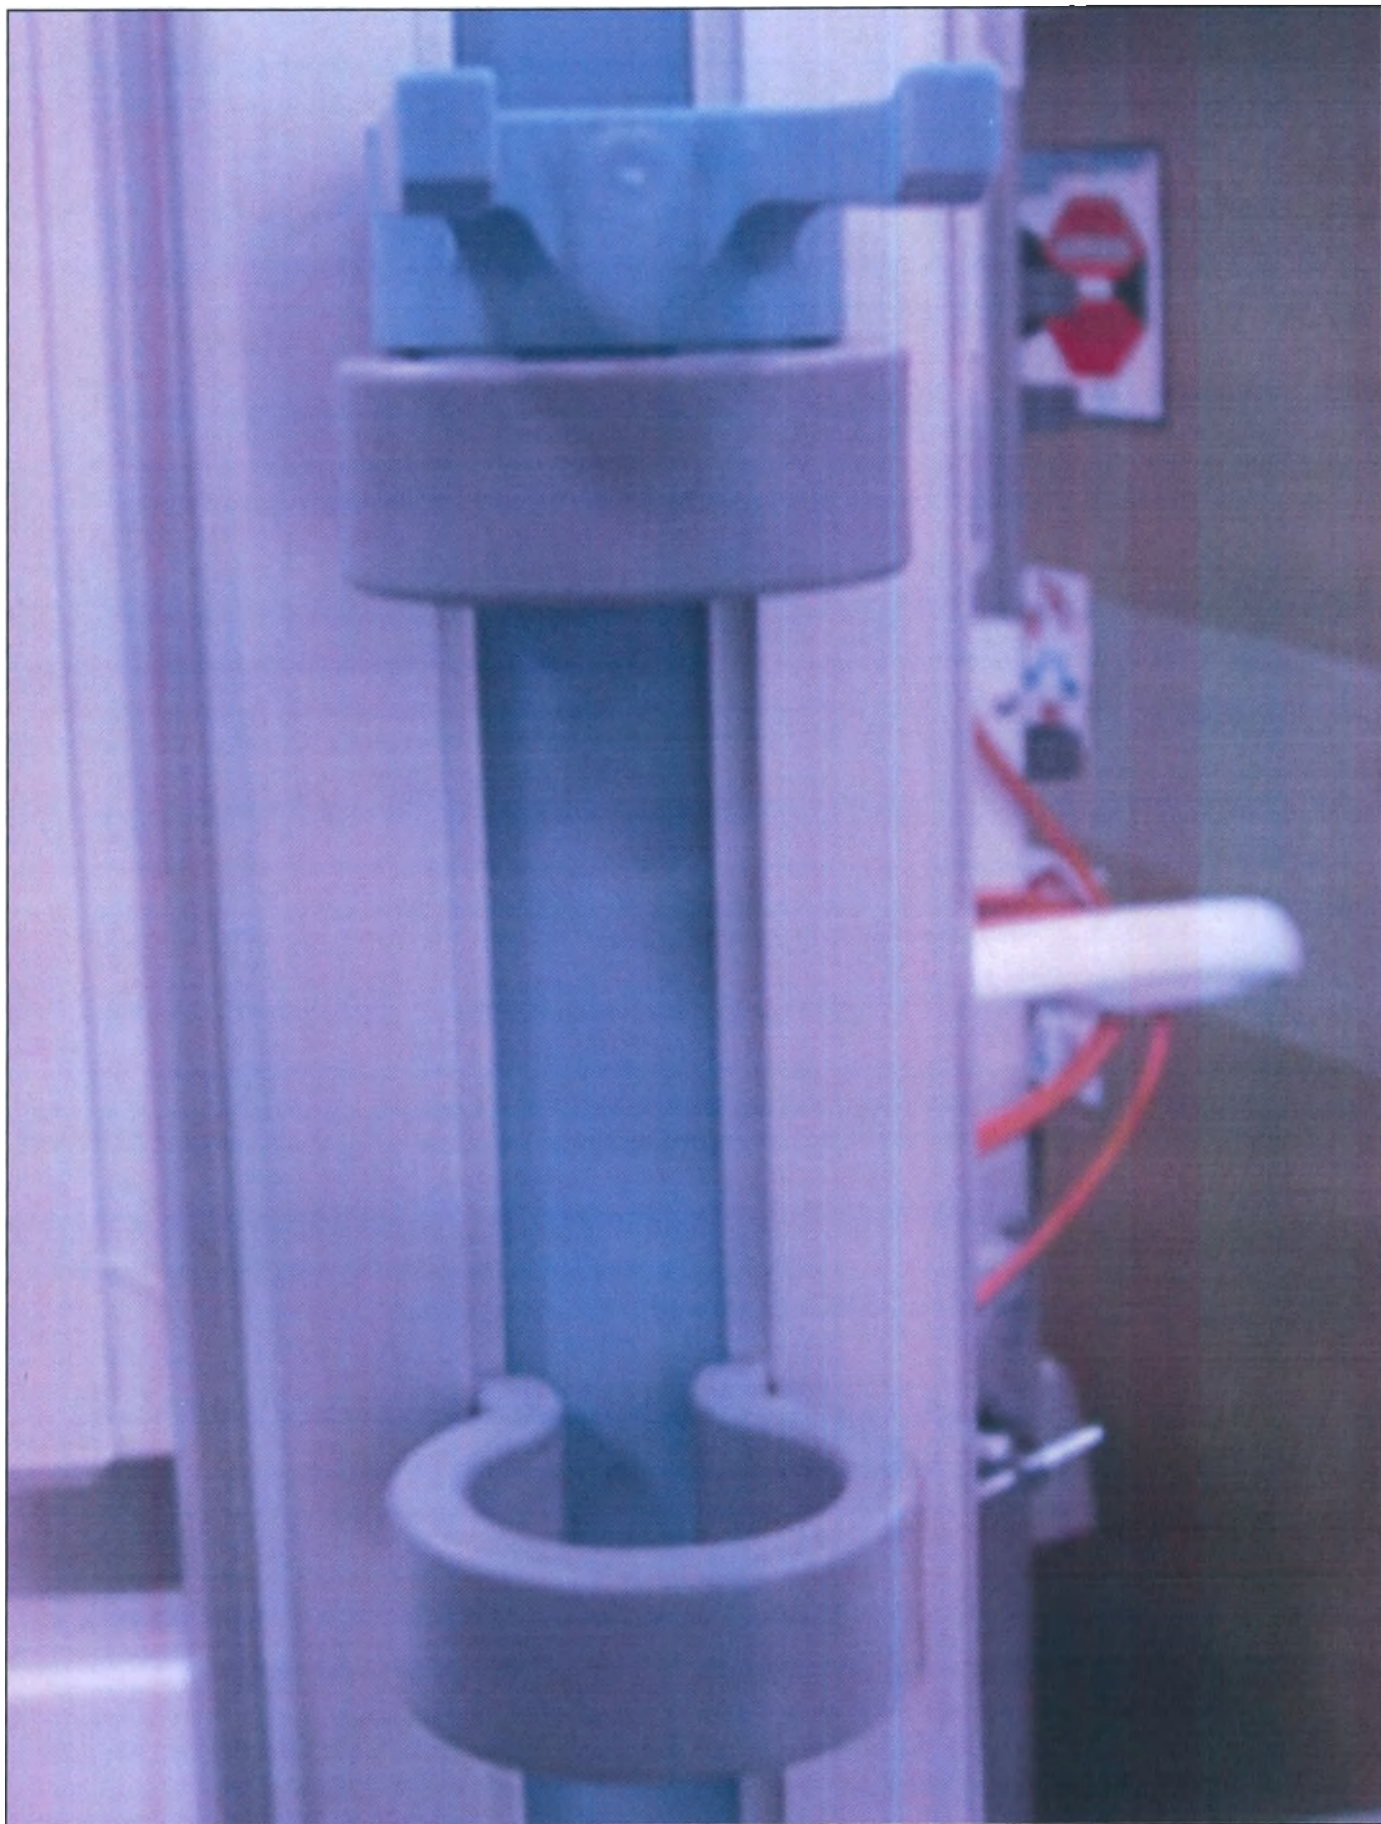


Держатели, зажимы и крепежи для трубок, газовых баллонов, приборов – крепеж для трубок



Держатели, зажимы и крепежи для трубок, газовых баллонов, приборов – держатель газовых баллонов




Держатели, зажимы и крепежи для трубок, газовых баллонов, приборов – крепеж для приборов

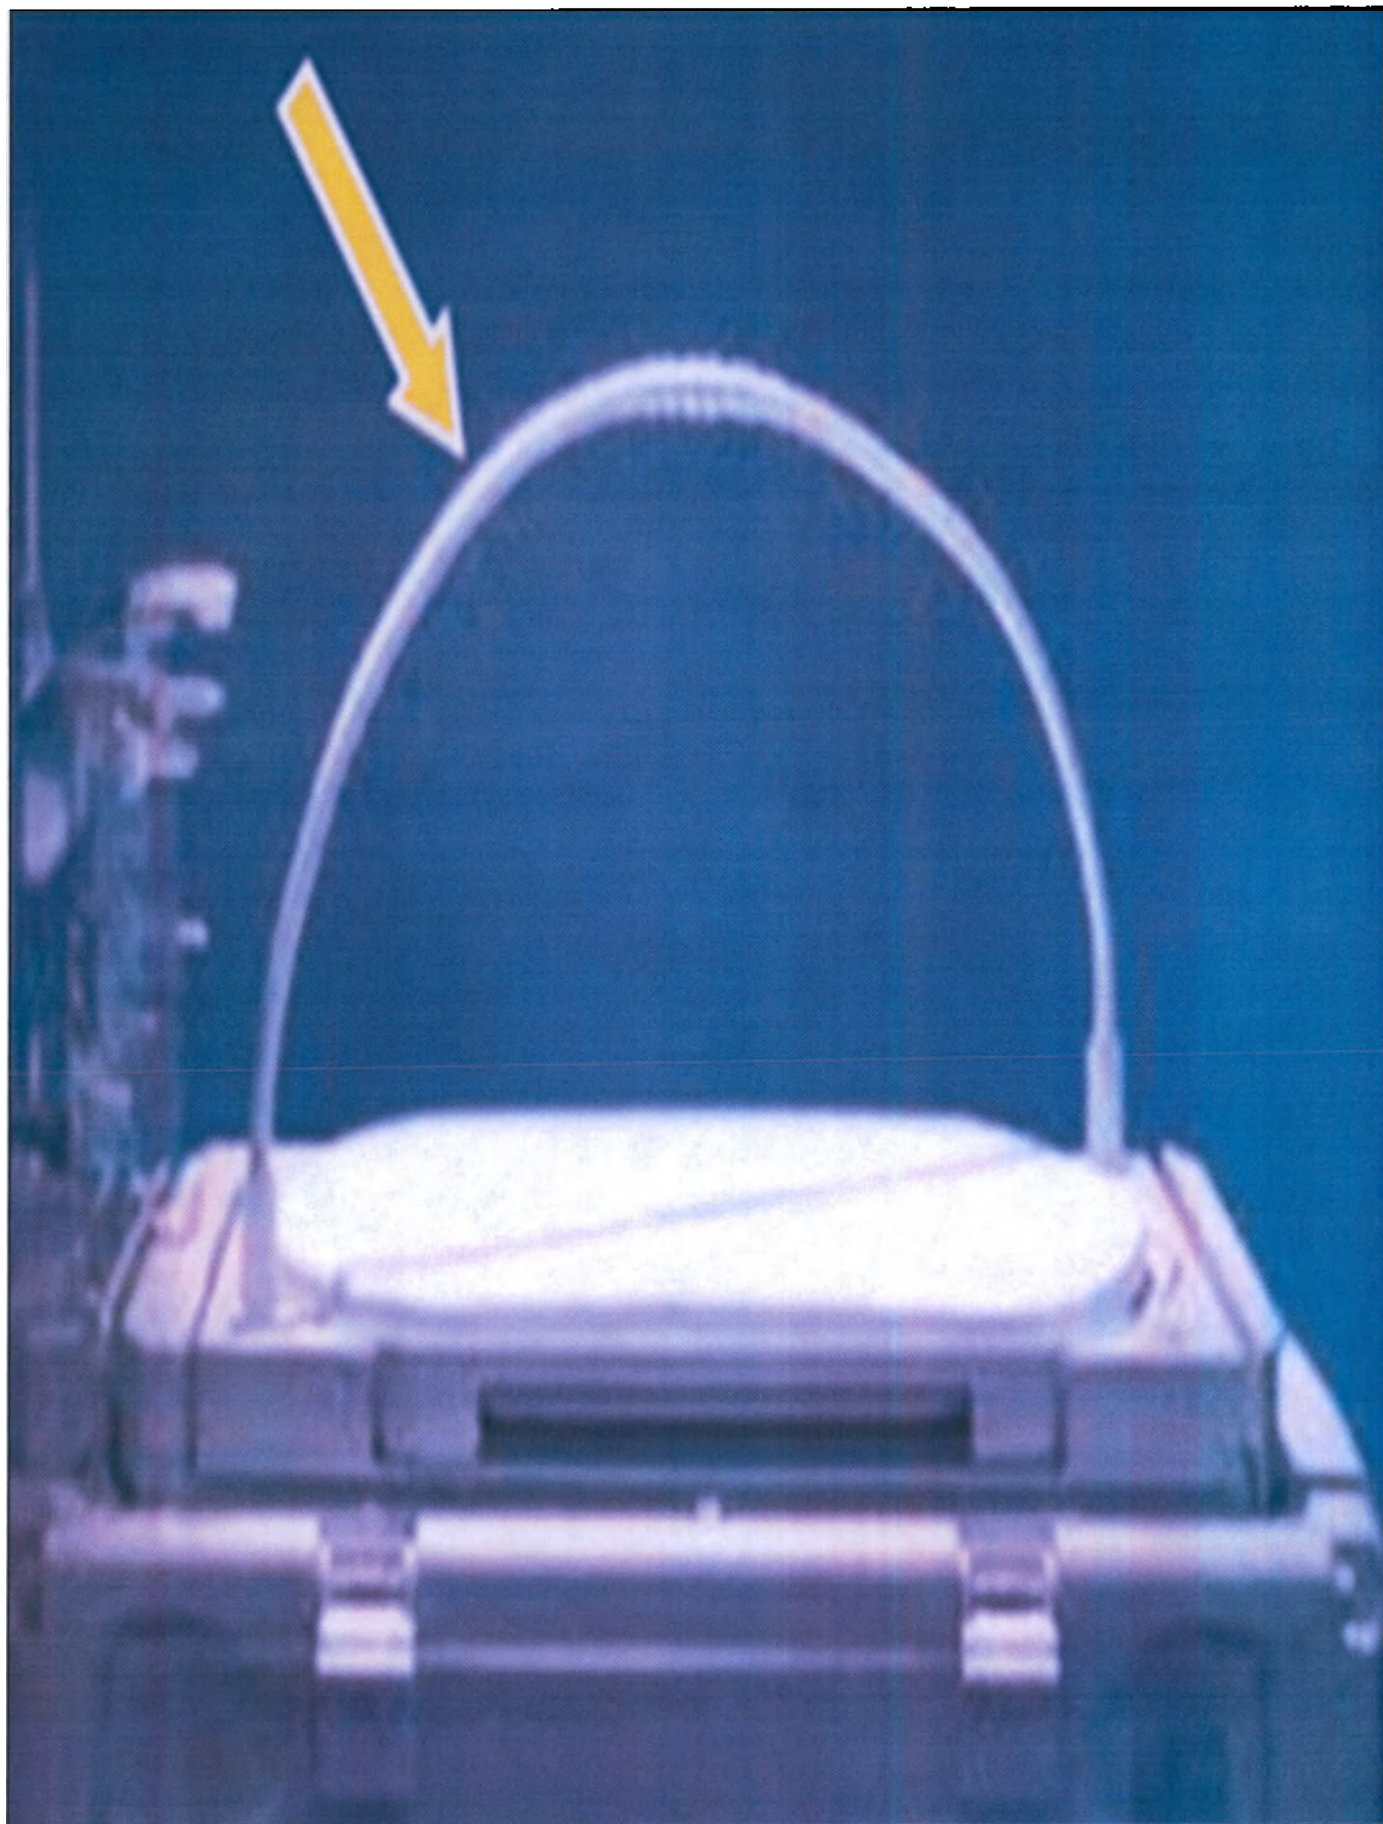

Стойка на колесах: с фиксированным основанием, с подъемным механизмом



Направляющие для приборов

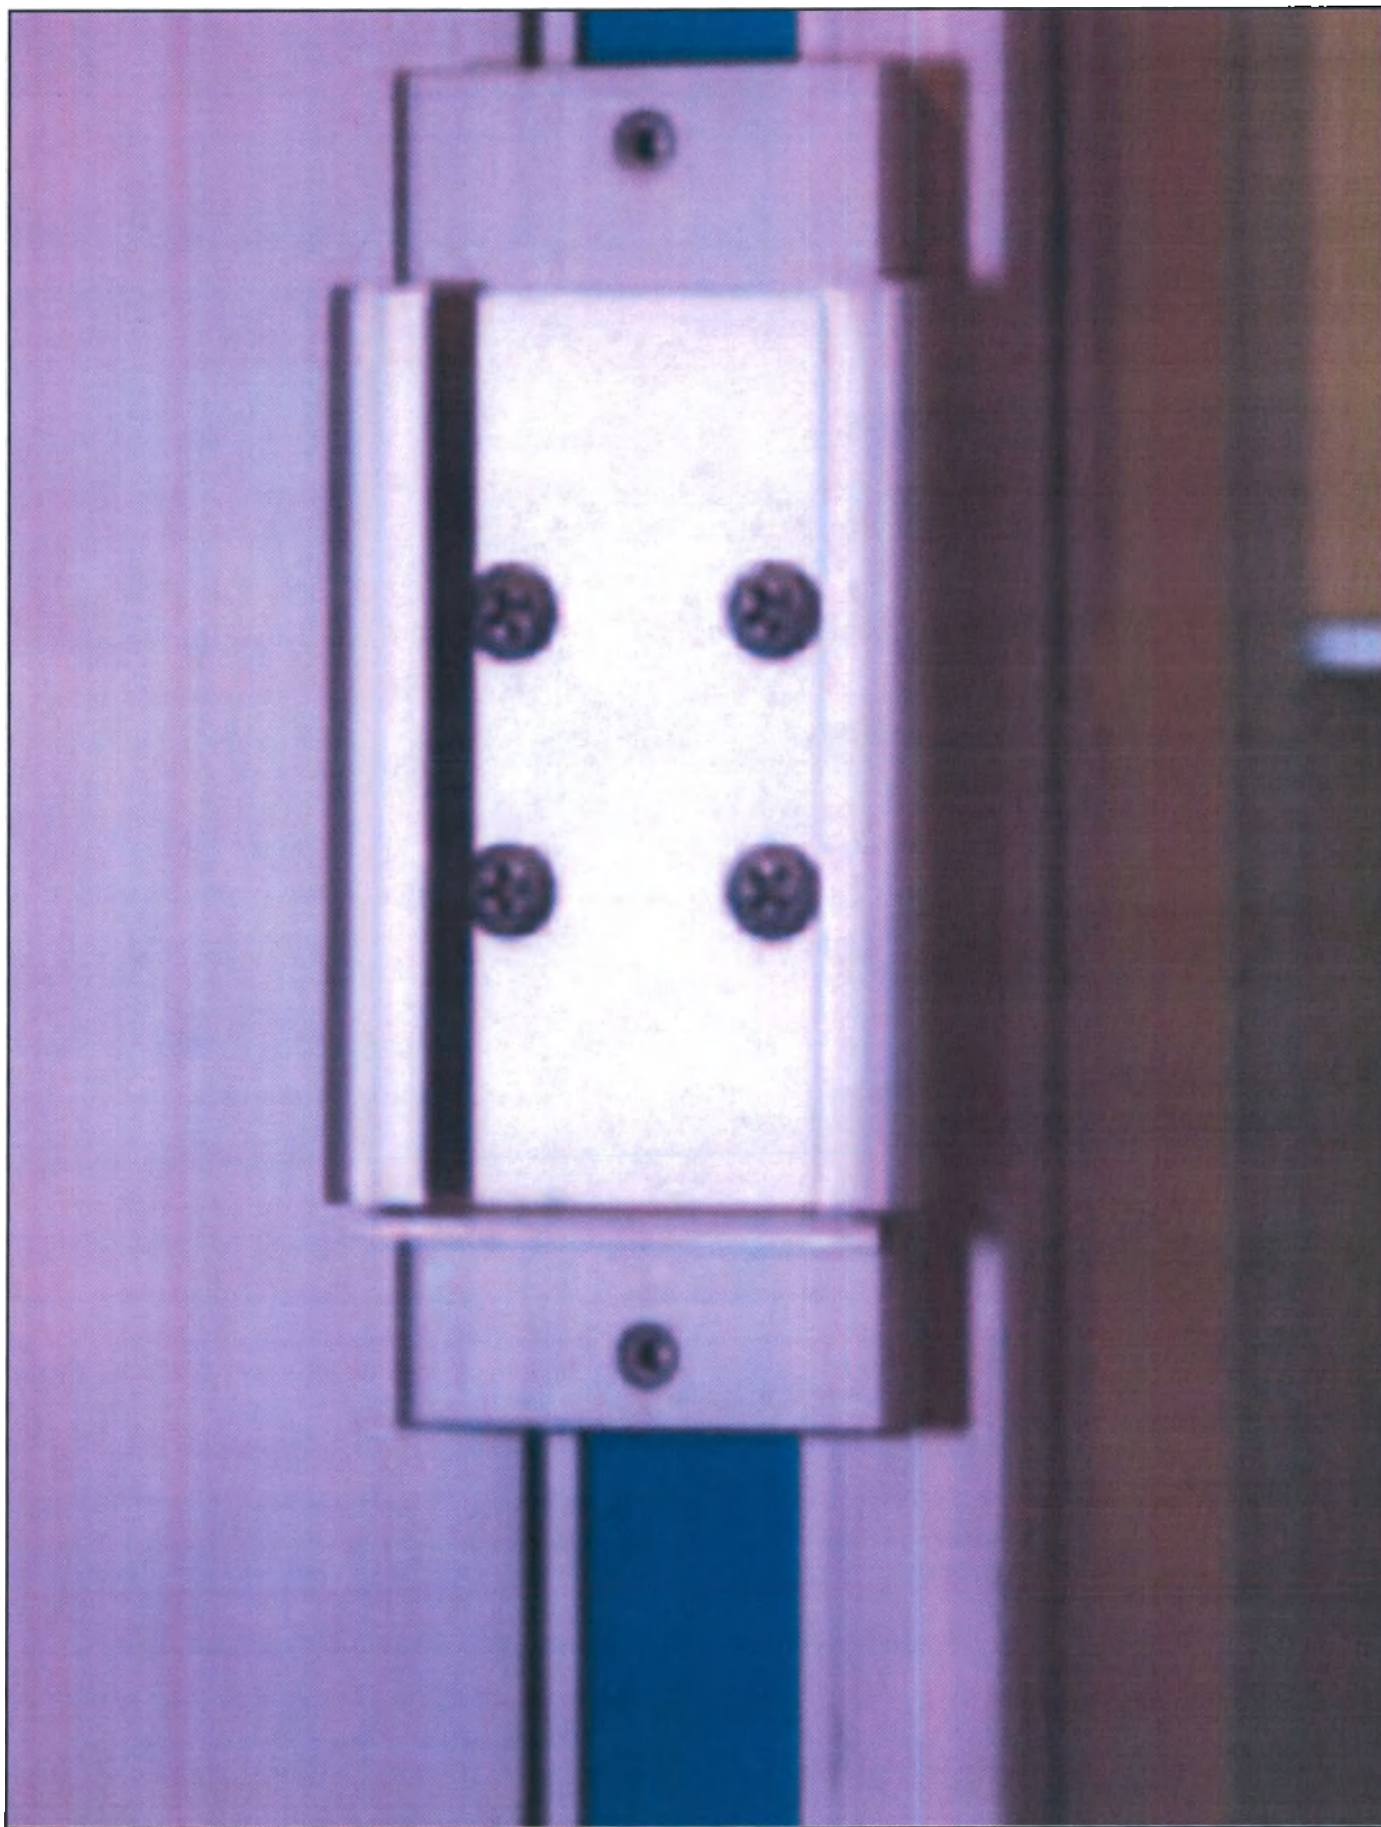

Направляющие для приборов



Направляющие для приборов




Направляющие для приборов



Матрасики, производитель GE Healthcare, США




Защитные чехлы для матрасиков, производитель Carefusion, США

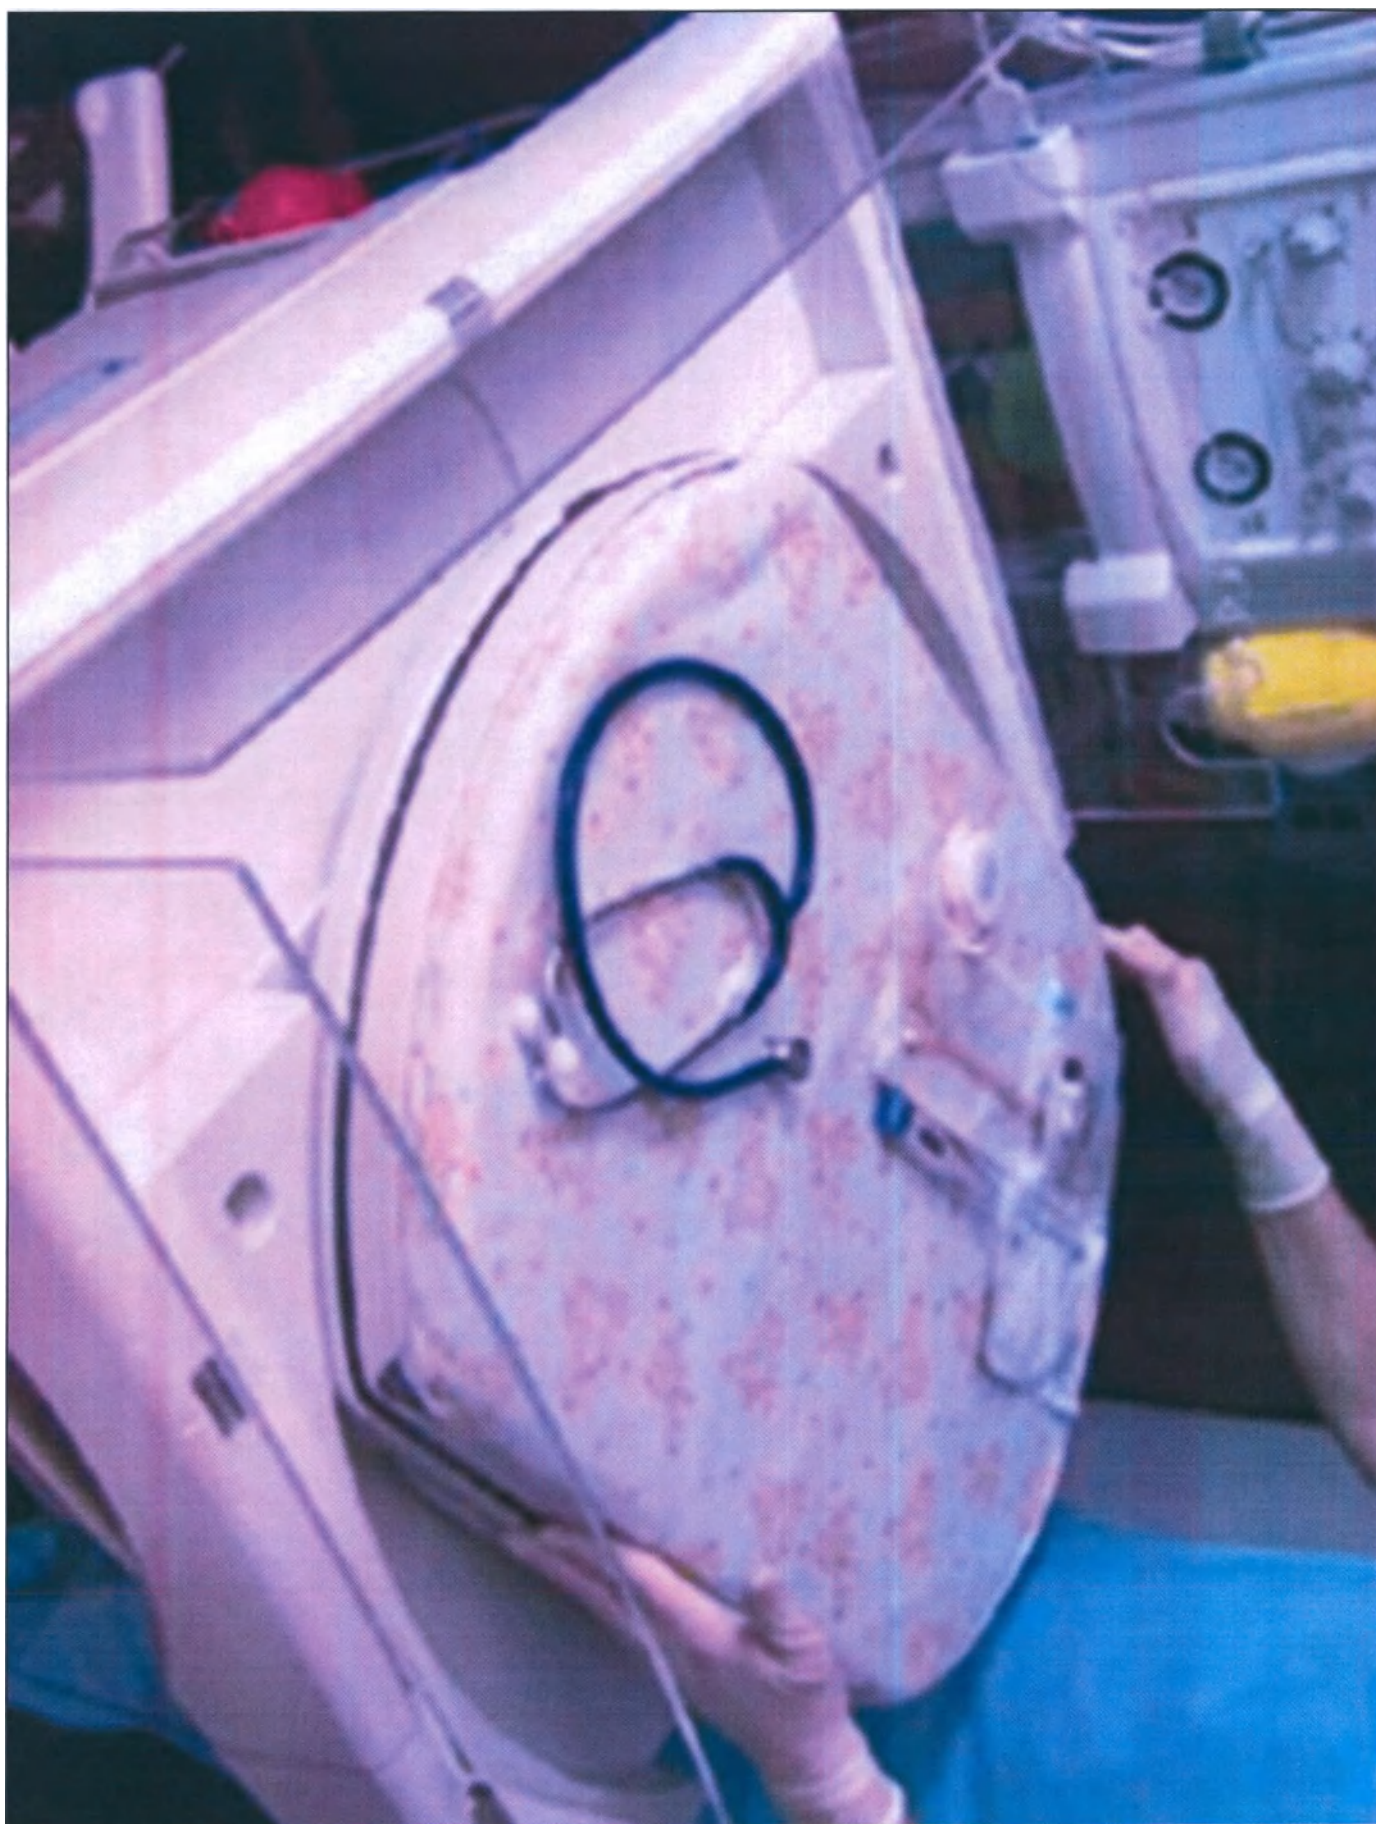


Укладки-гнездышки для новорожденных, производитель Lumitex, США



Ящики для хранения принадлежностей

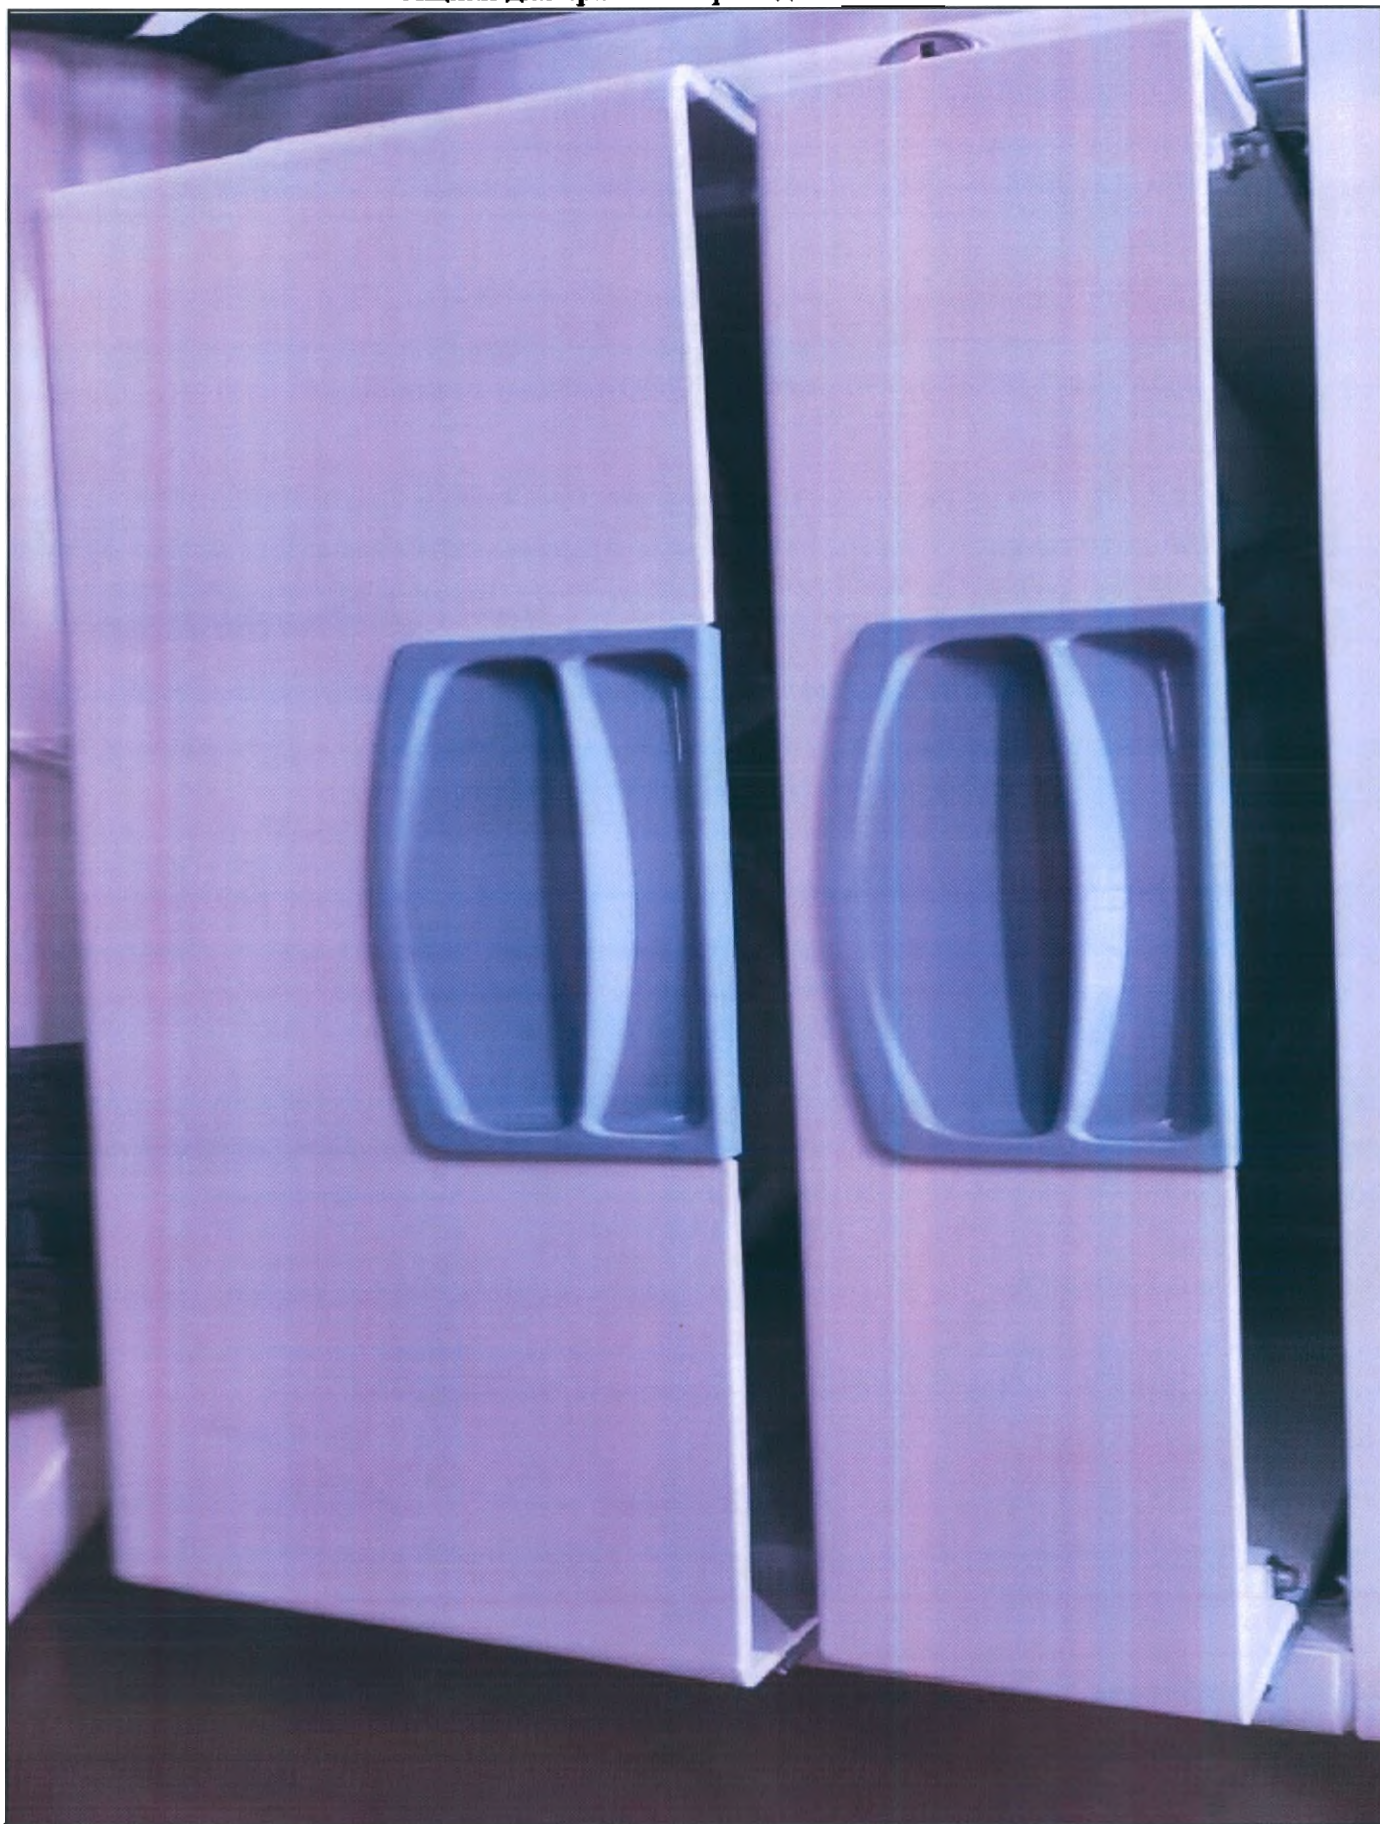

Лотки: угловые, для рентген кассет

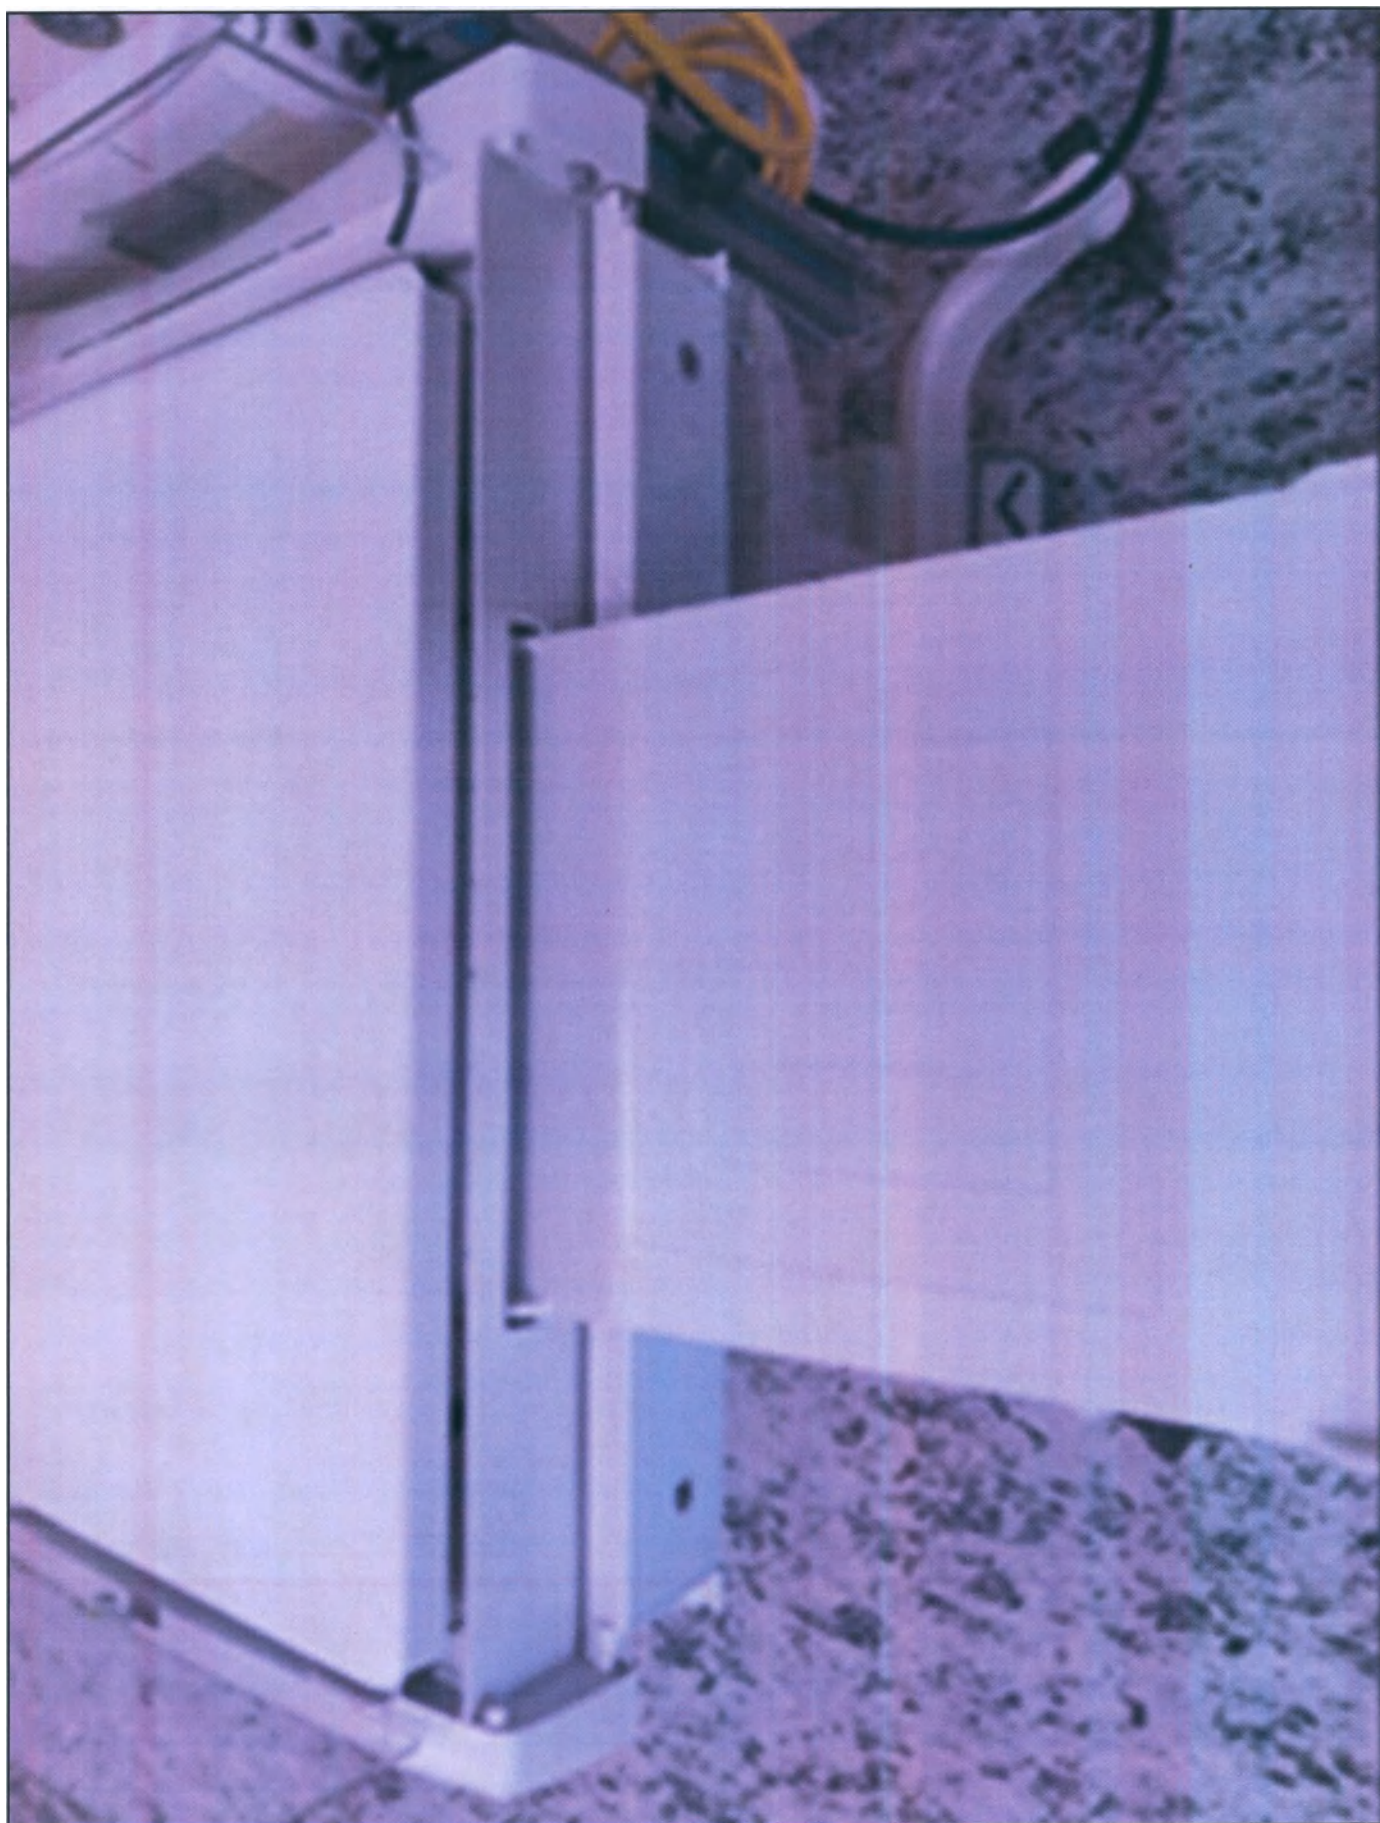

Полки: мониторные, инструментальные



Полки: мониторные, инструментальные



Адаптеры, производитель BAY Corporation, США



Коннекторы, производитель GE Healthcare, США



Кабель пациента, производитель BioMed Devices, США



Кабель пациента, производитель BioMed Devices, США




Кабель пациента, производитель BioMed Devices, США



Кабель удлинительный, производитель BioMed Devices, США




Теплоотражающие пластины для датчиков, производитель Vyair Medical INC, США

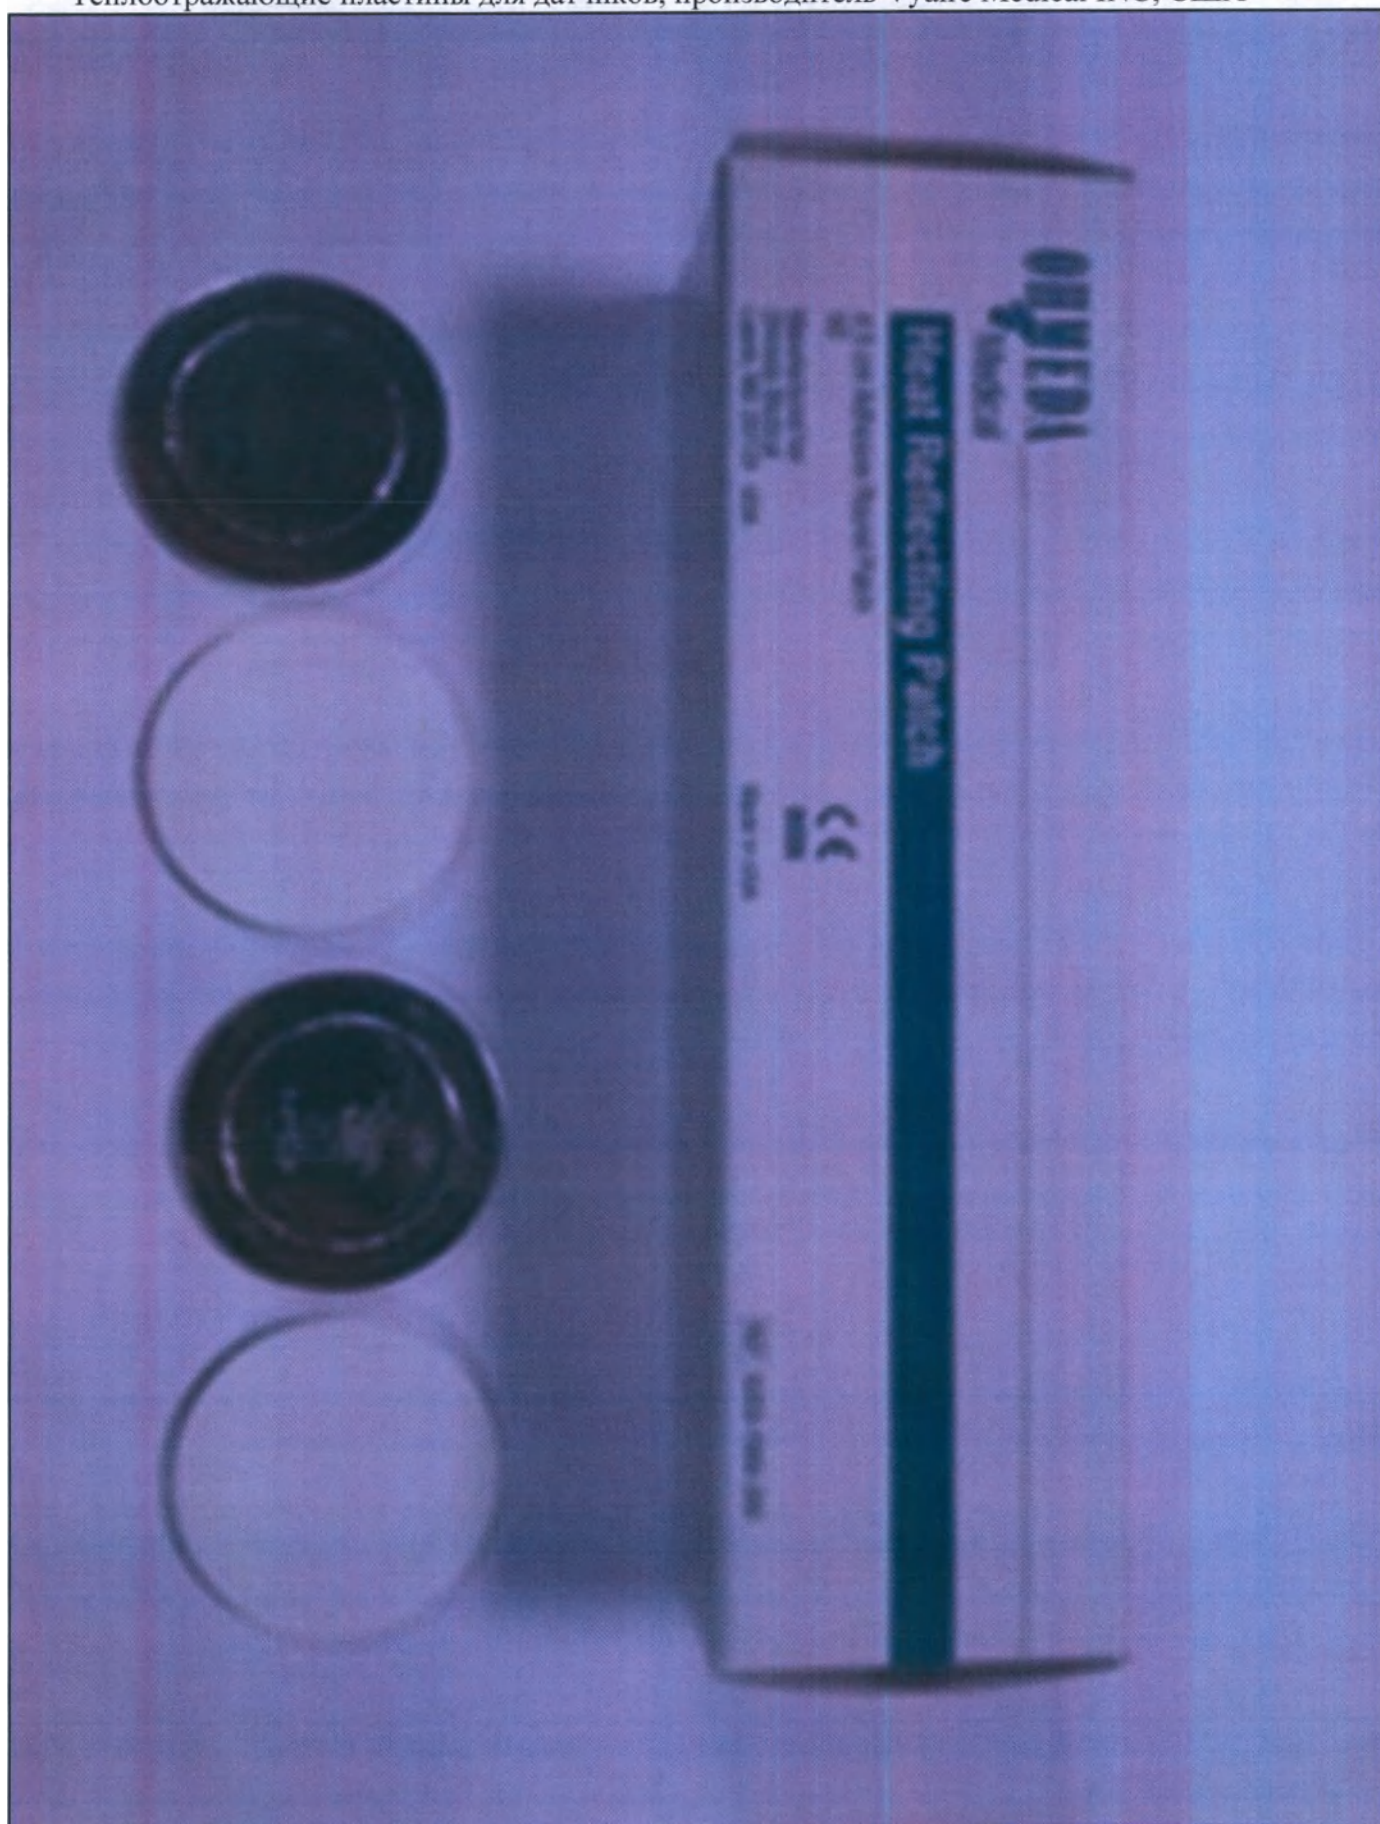

Шланги для кислорода и воздуха, производитель Ohio Medical Corporation, США





Шланг для аспиратора, пациента, производитель Ohio Medical Corporation, США

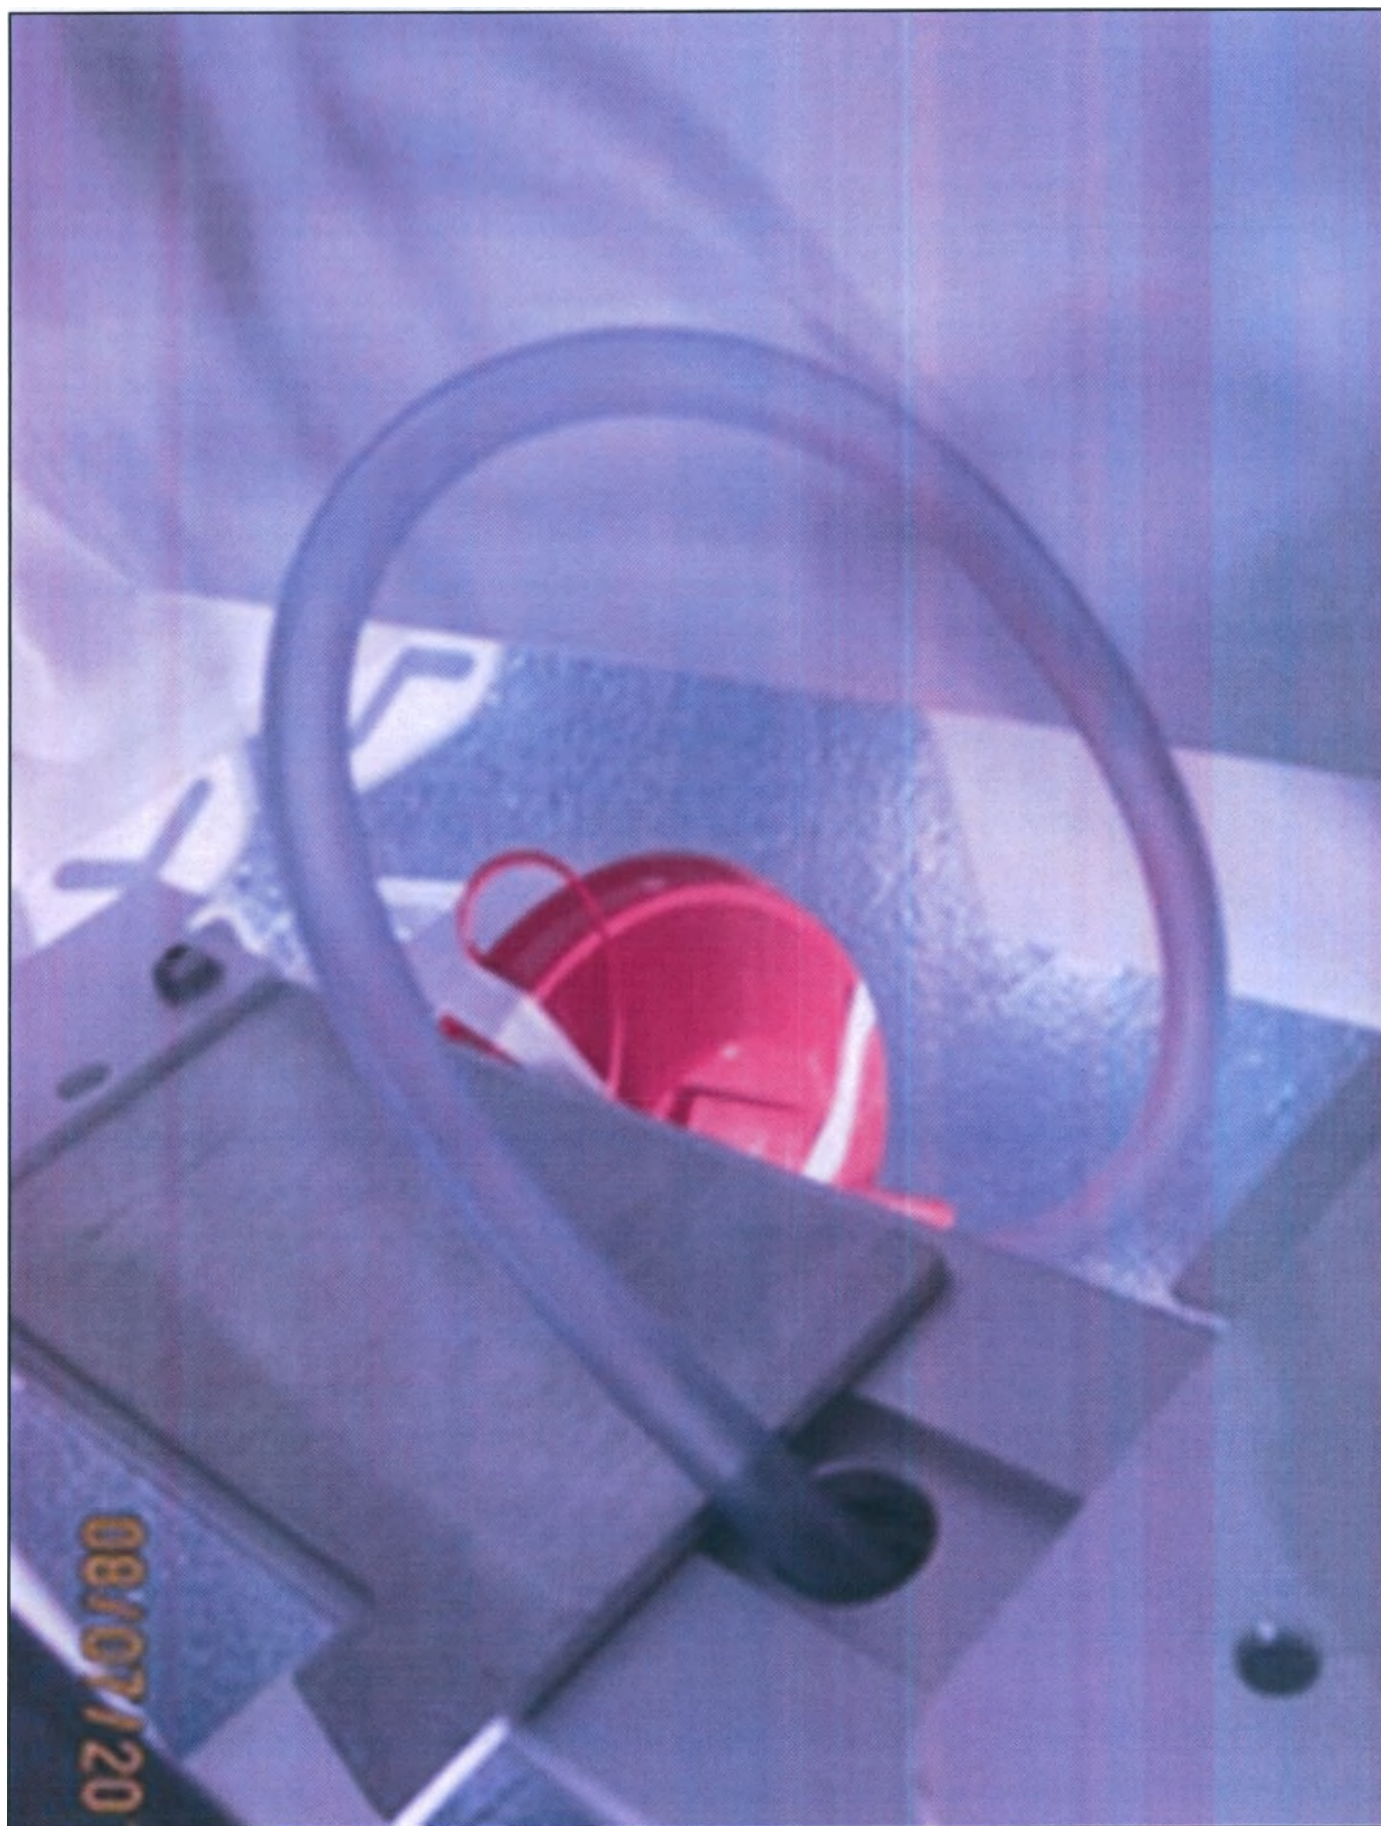


Емкости для аспиратора, производитель Bemis Healthcare, США




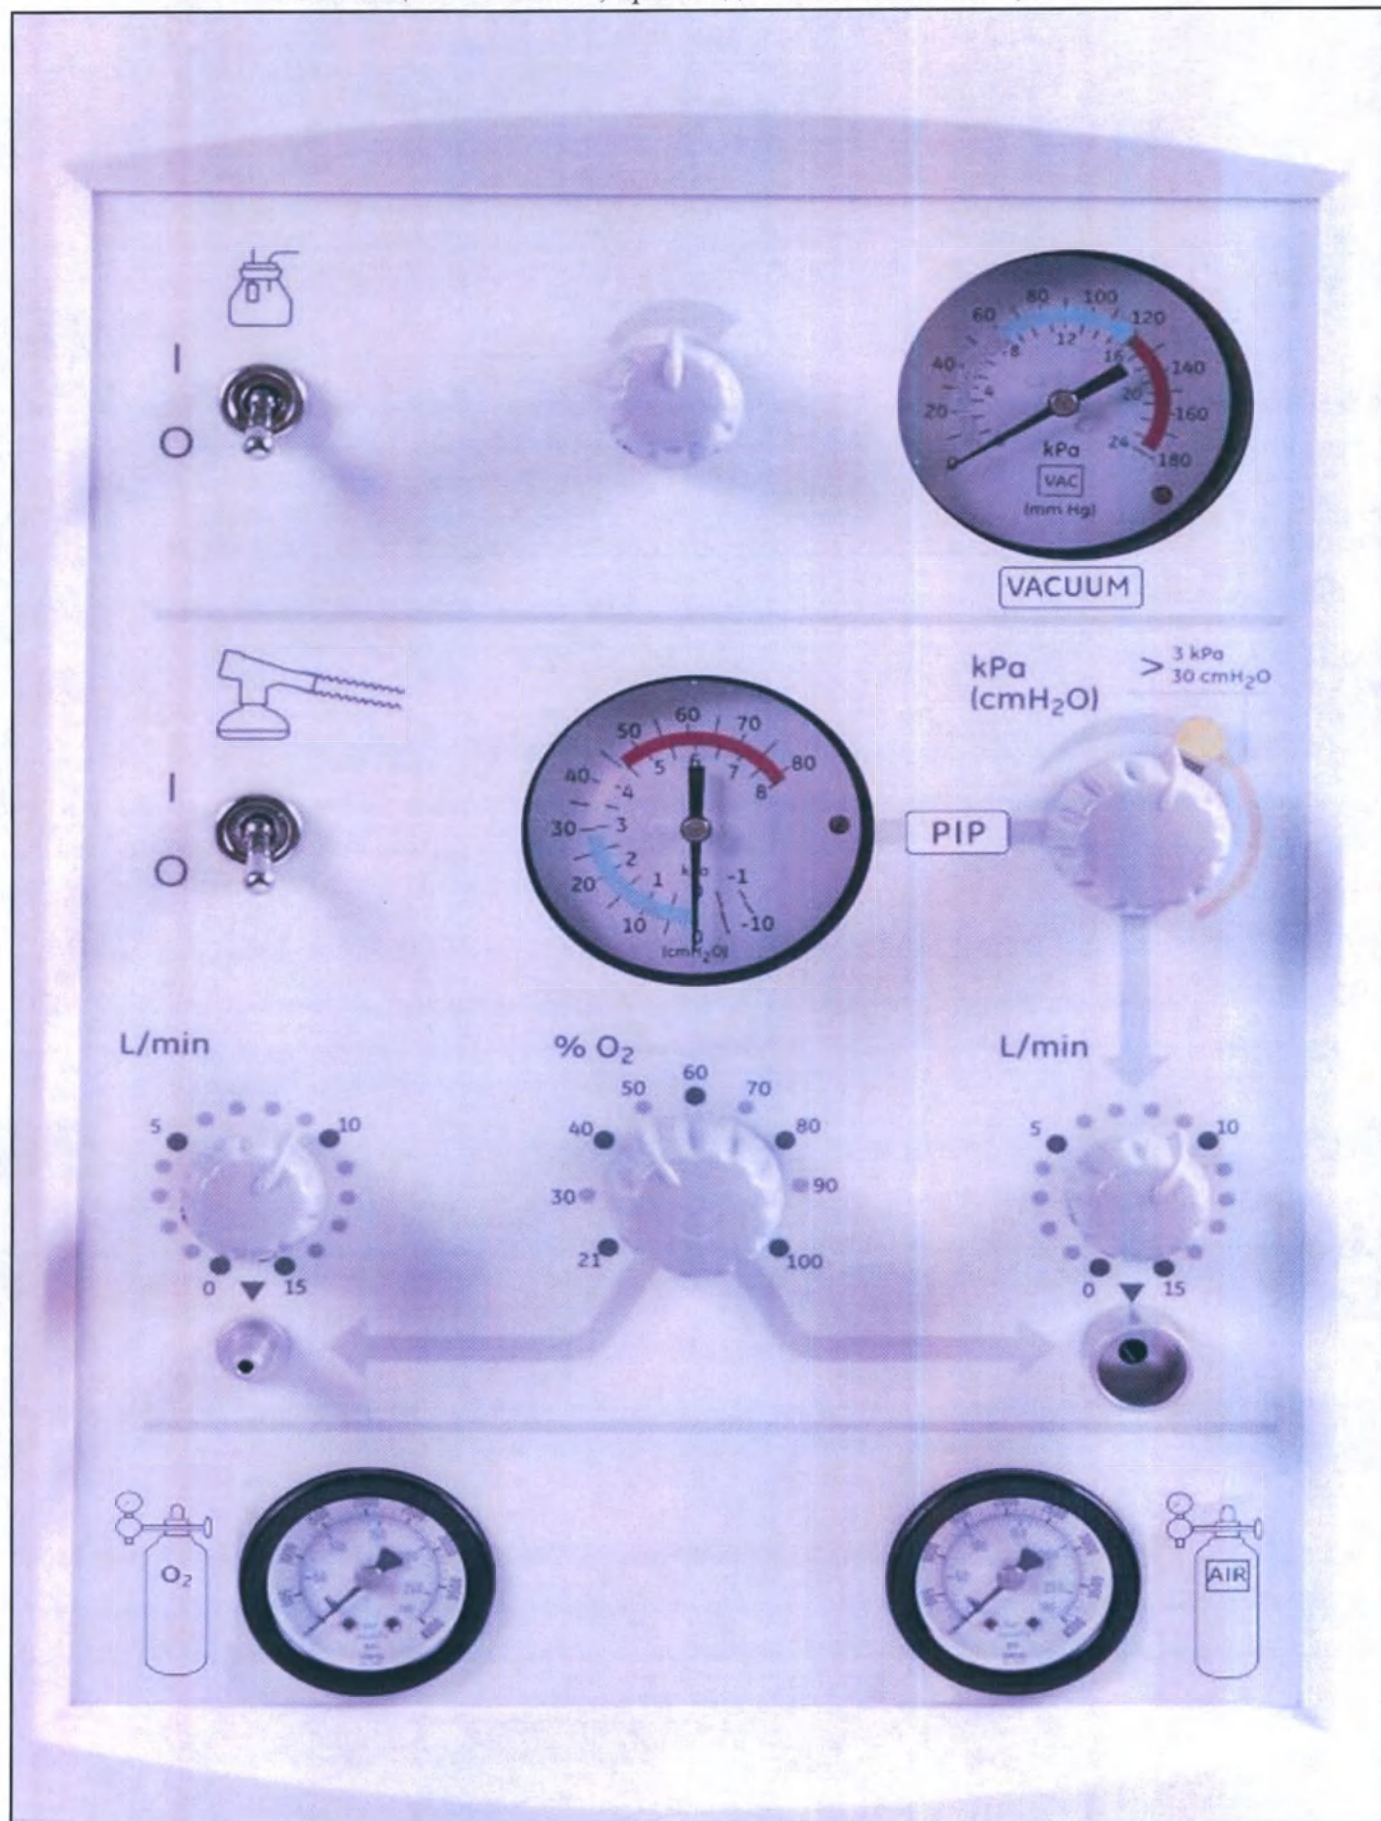

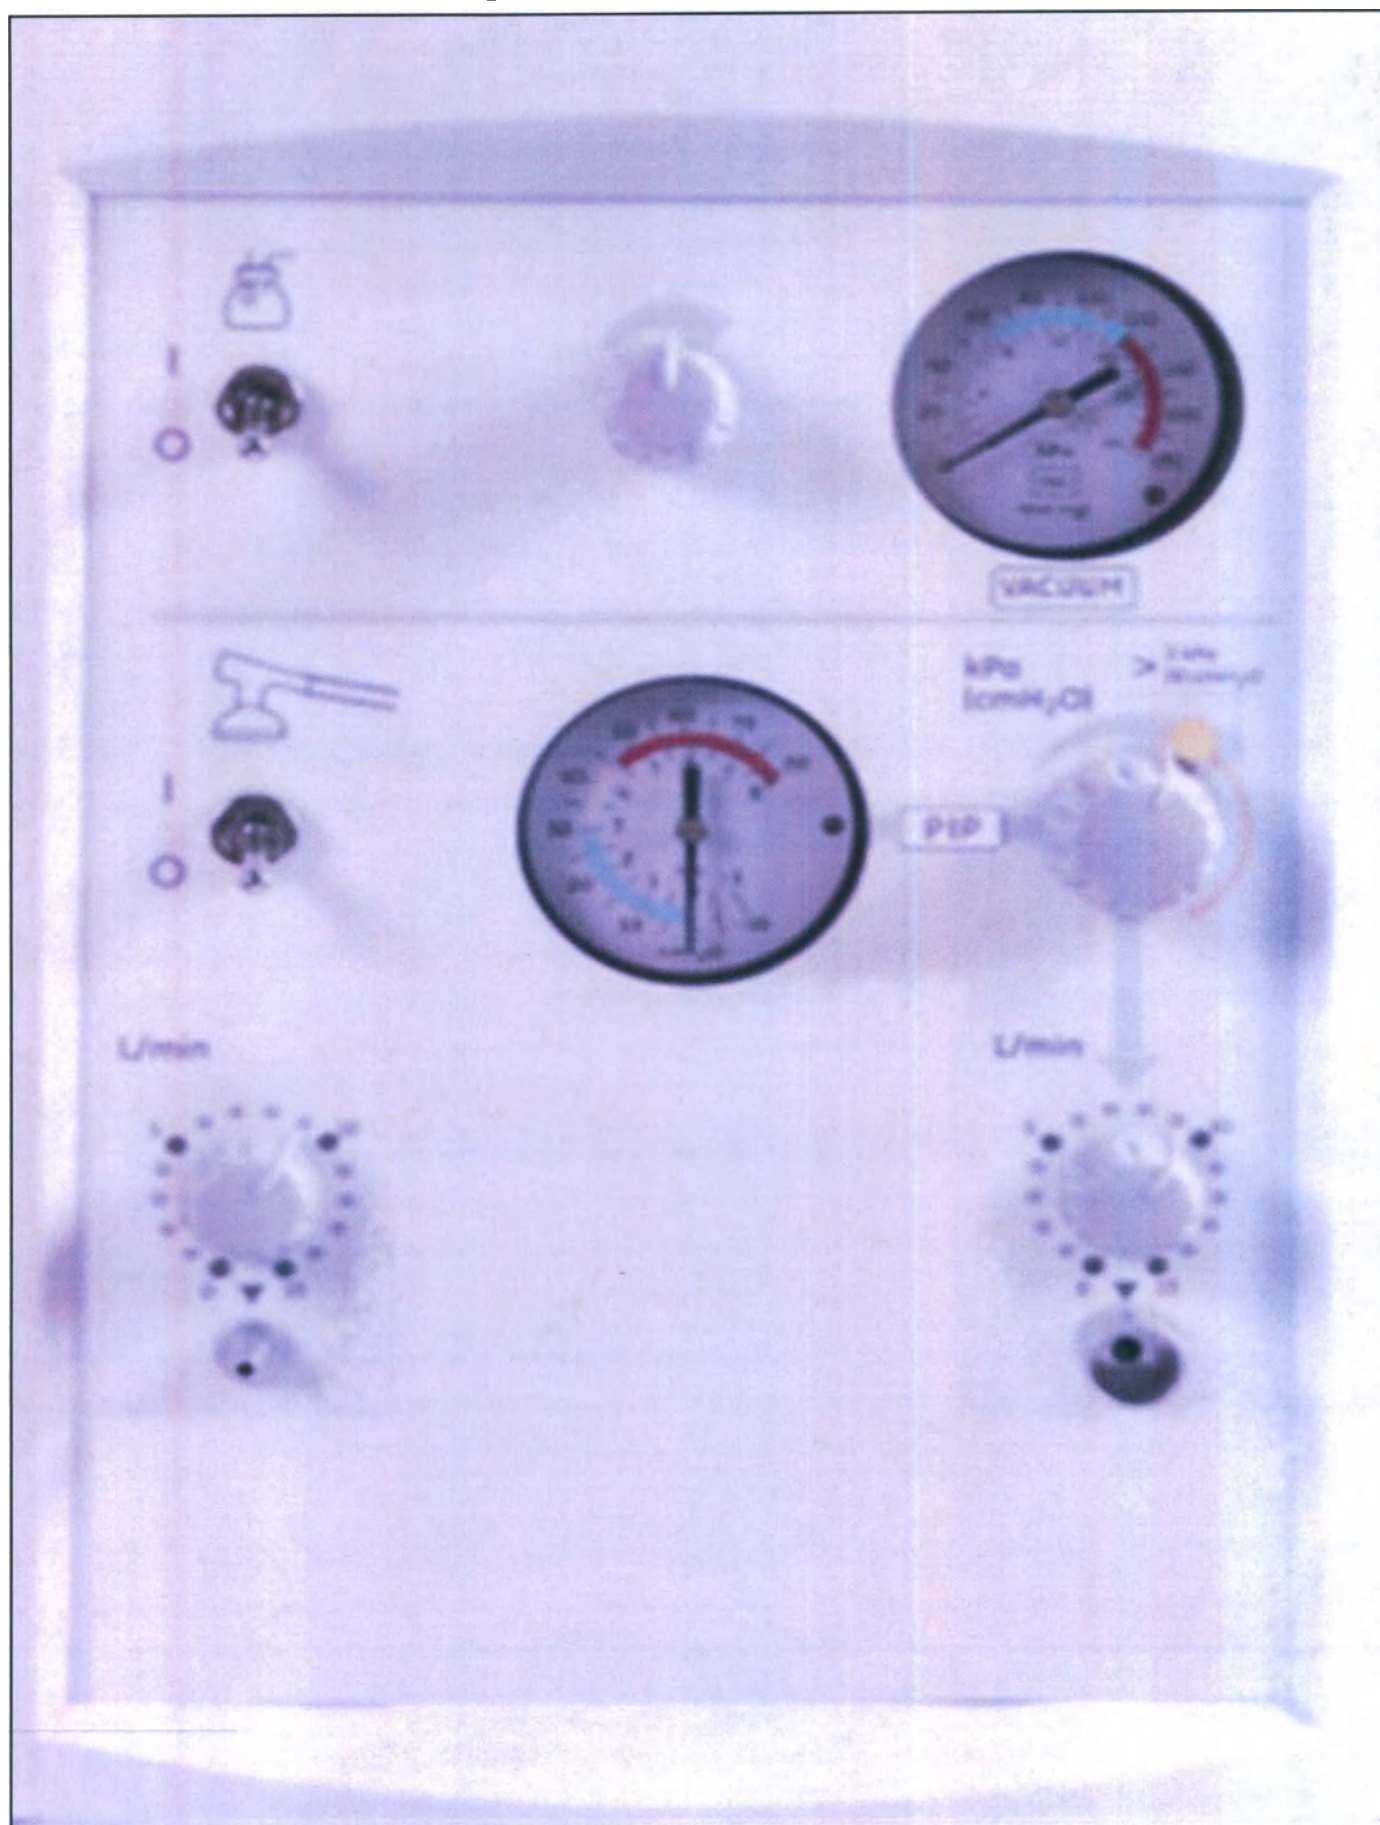

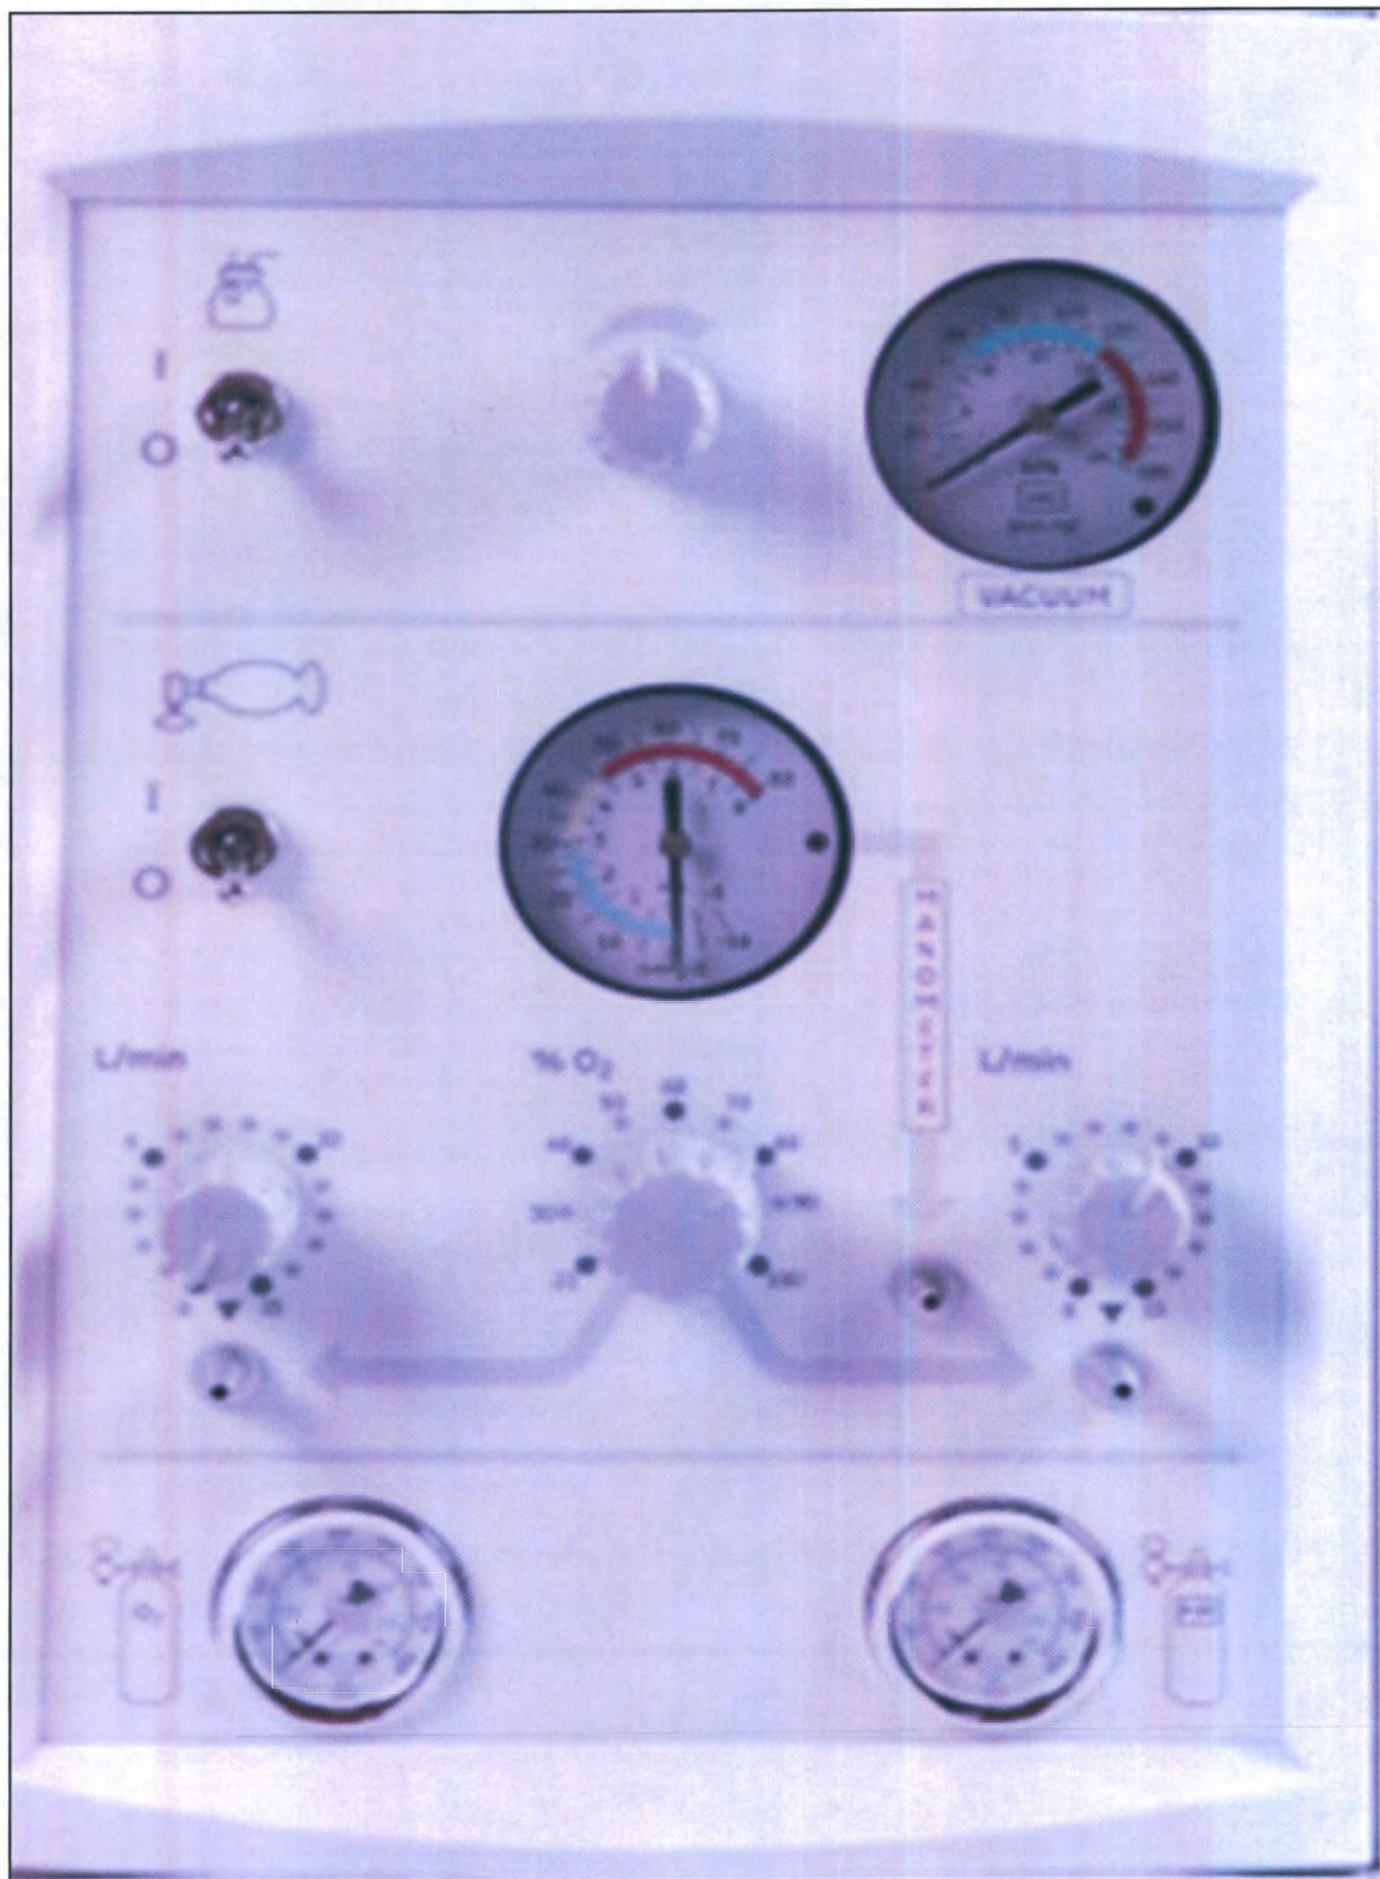


Реанимационные блоки, производитель GE Healthcare, США

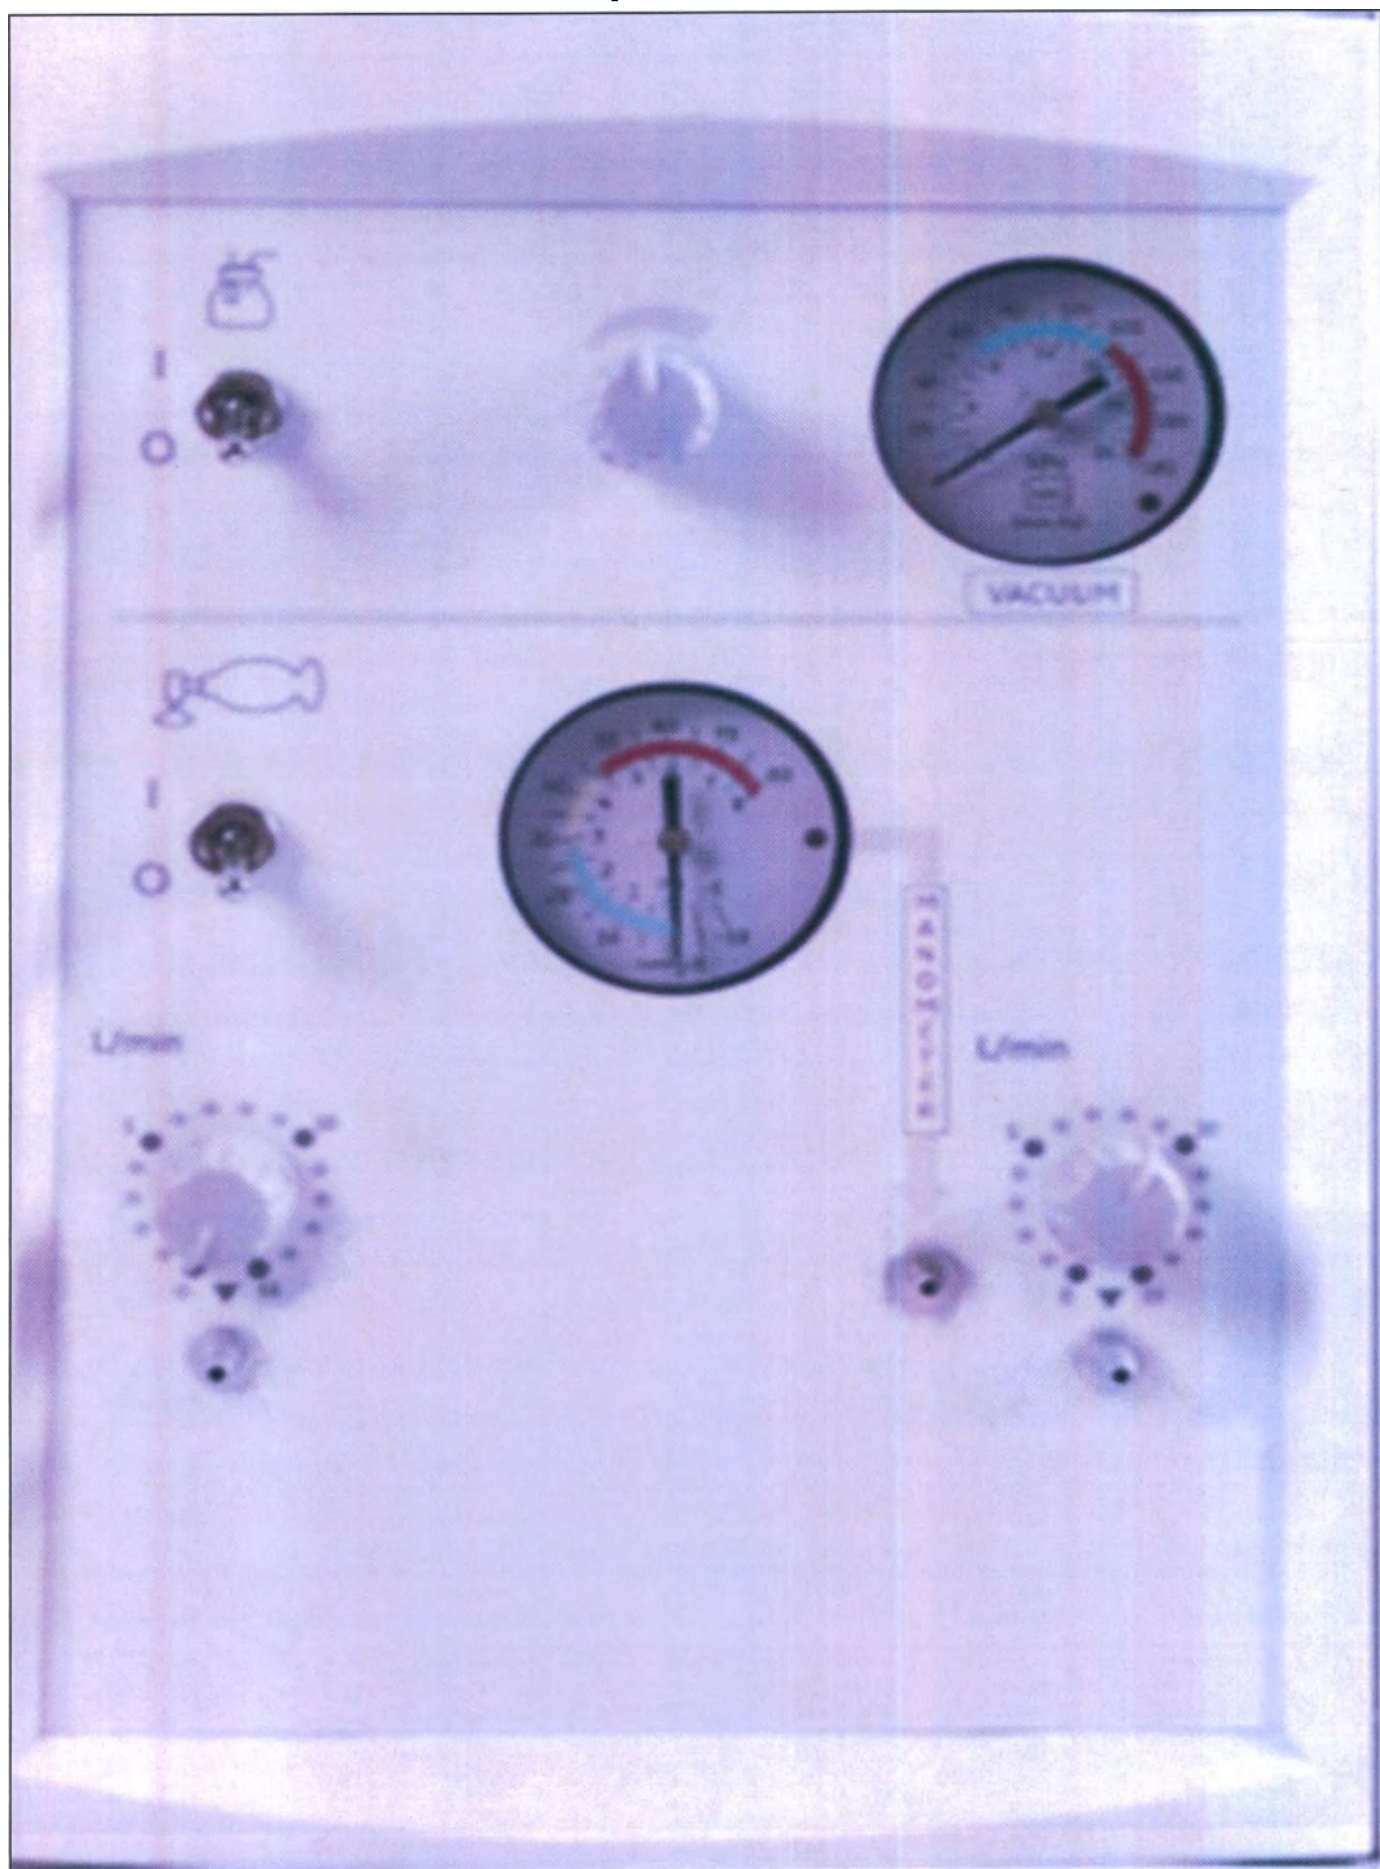

Корзина для принадлежностей



Панели для разводки трубок дополнительные

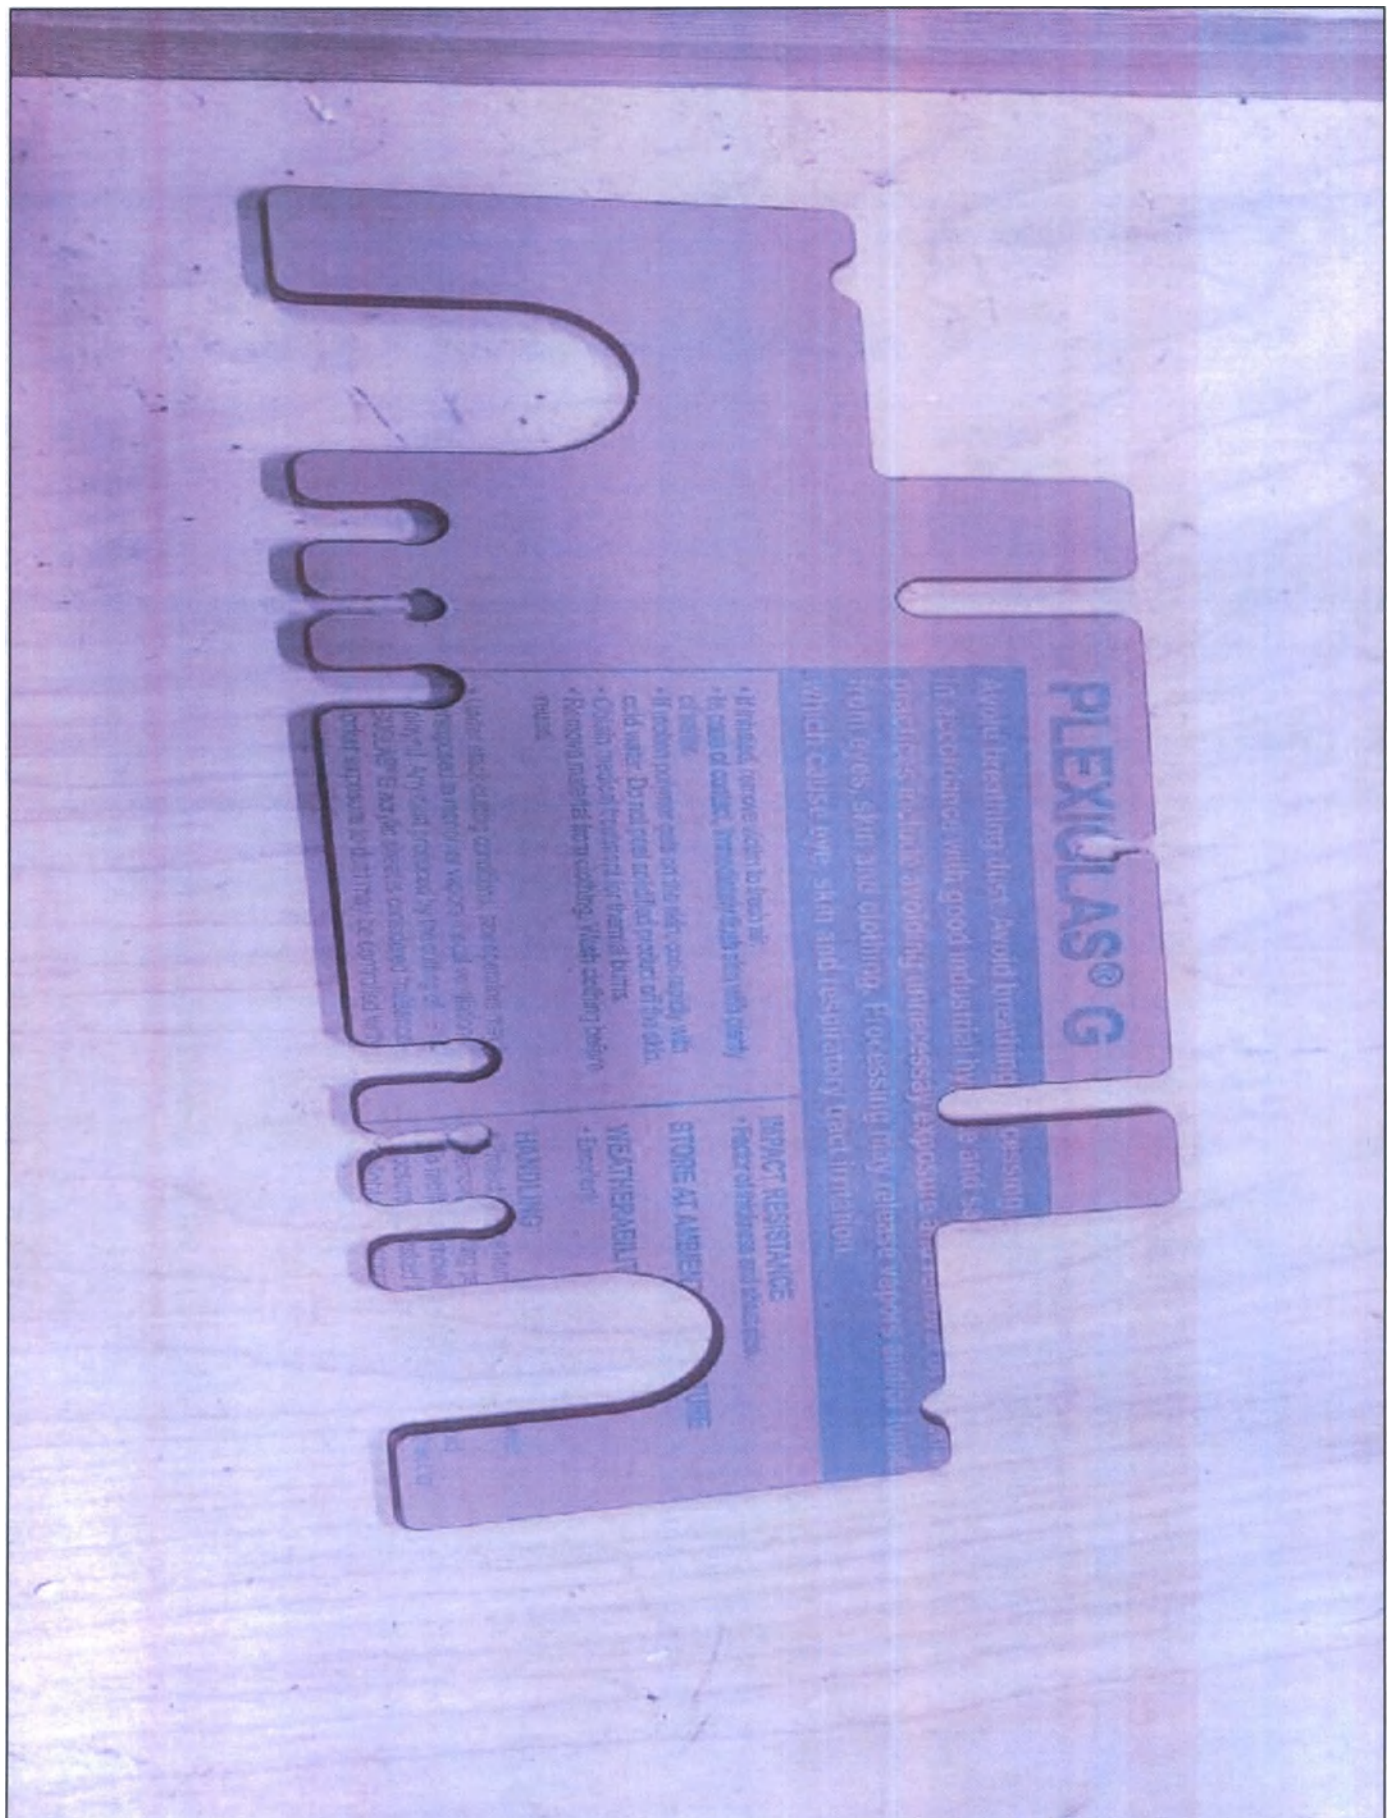

Кронштейны для мониторов



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 69 лист(ов)
Директор департамента Регистрации
и Сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
Харитонов А.П.



Anton Smov