



ACROBIOTECH, Inc.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

**ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИГЕНОВ КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2,
ВИРУСОВ ГРИППА А И В ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ В МАЗКЕ ИЗ НОСОГЛОТКИ
(COVID-19 AND INFLUENZA A+B ANTIGEN COMBO RAPID TEST)**

2022 г.


Общий вид медицинского изделия

Стерильный тампон в индивидуальной упаковке


Буфер

Контейнер для образца с наконечником


Тест-кассета в индивидуальной упаковке с осушителем

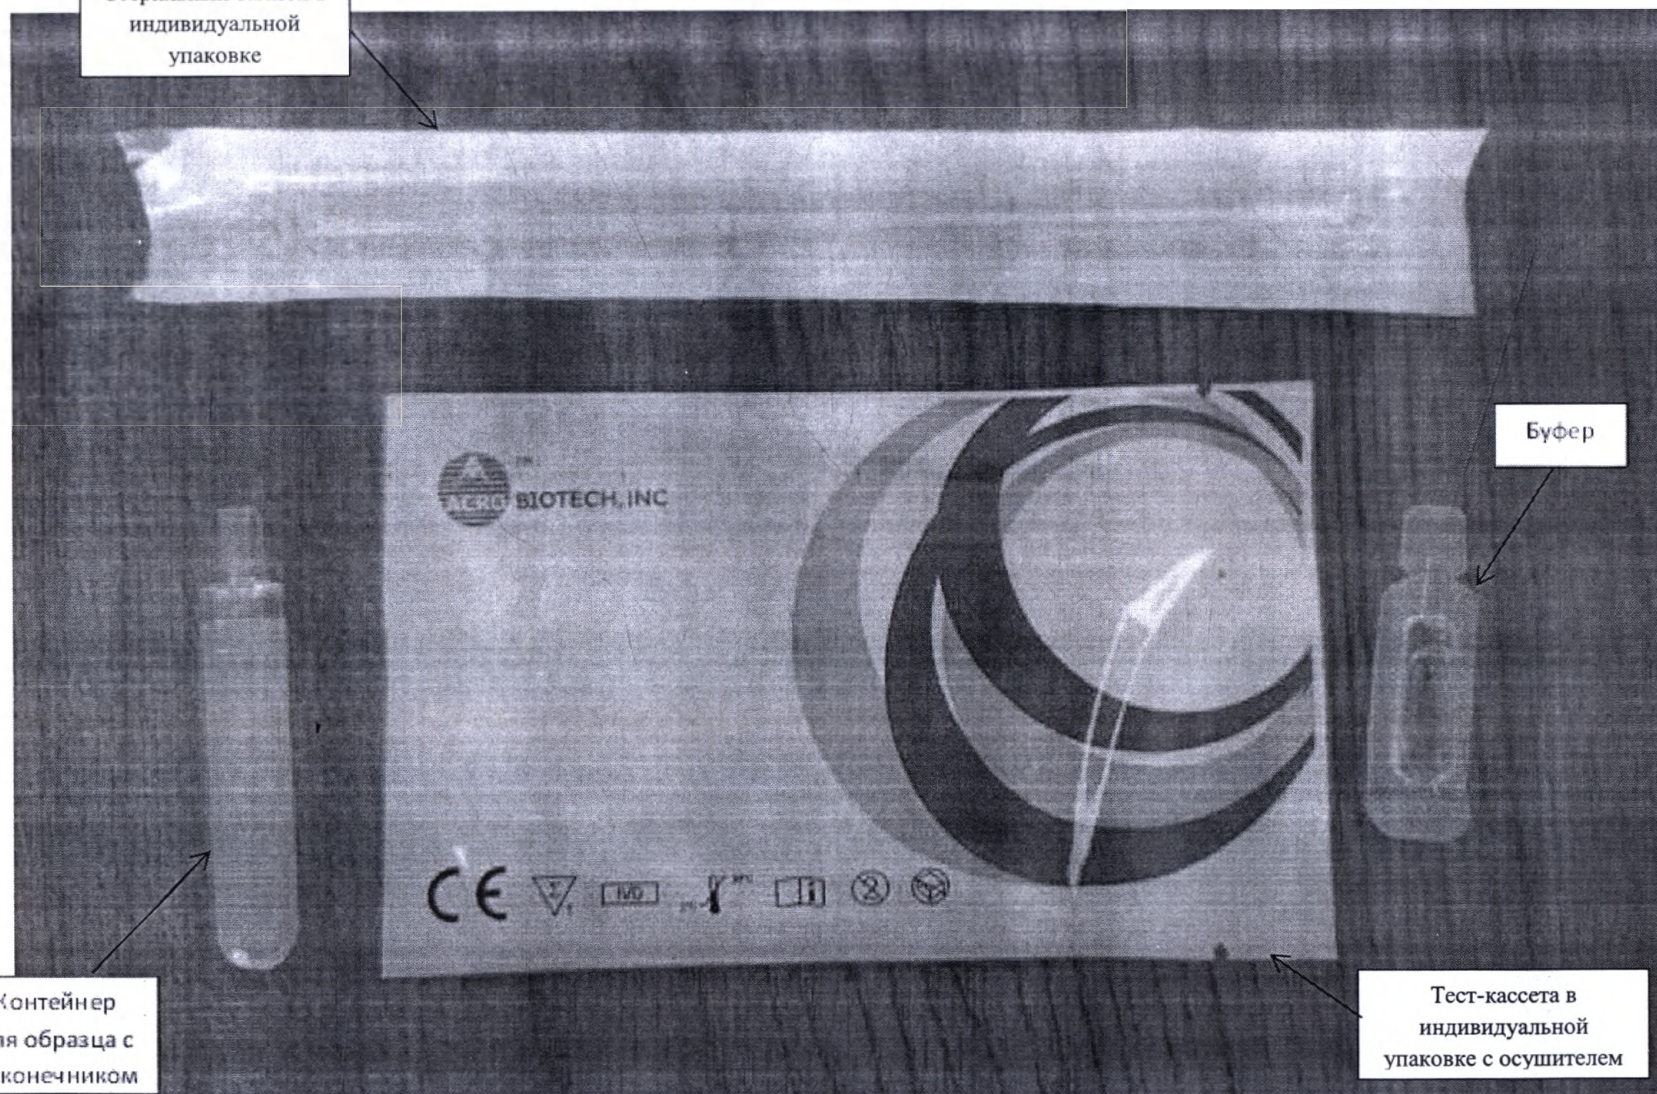

Тест-кассета

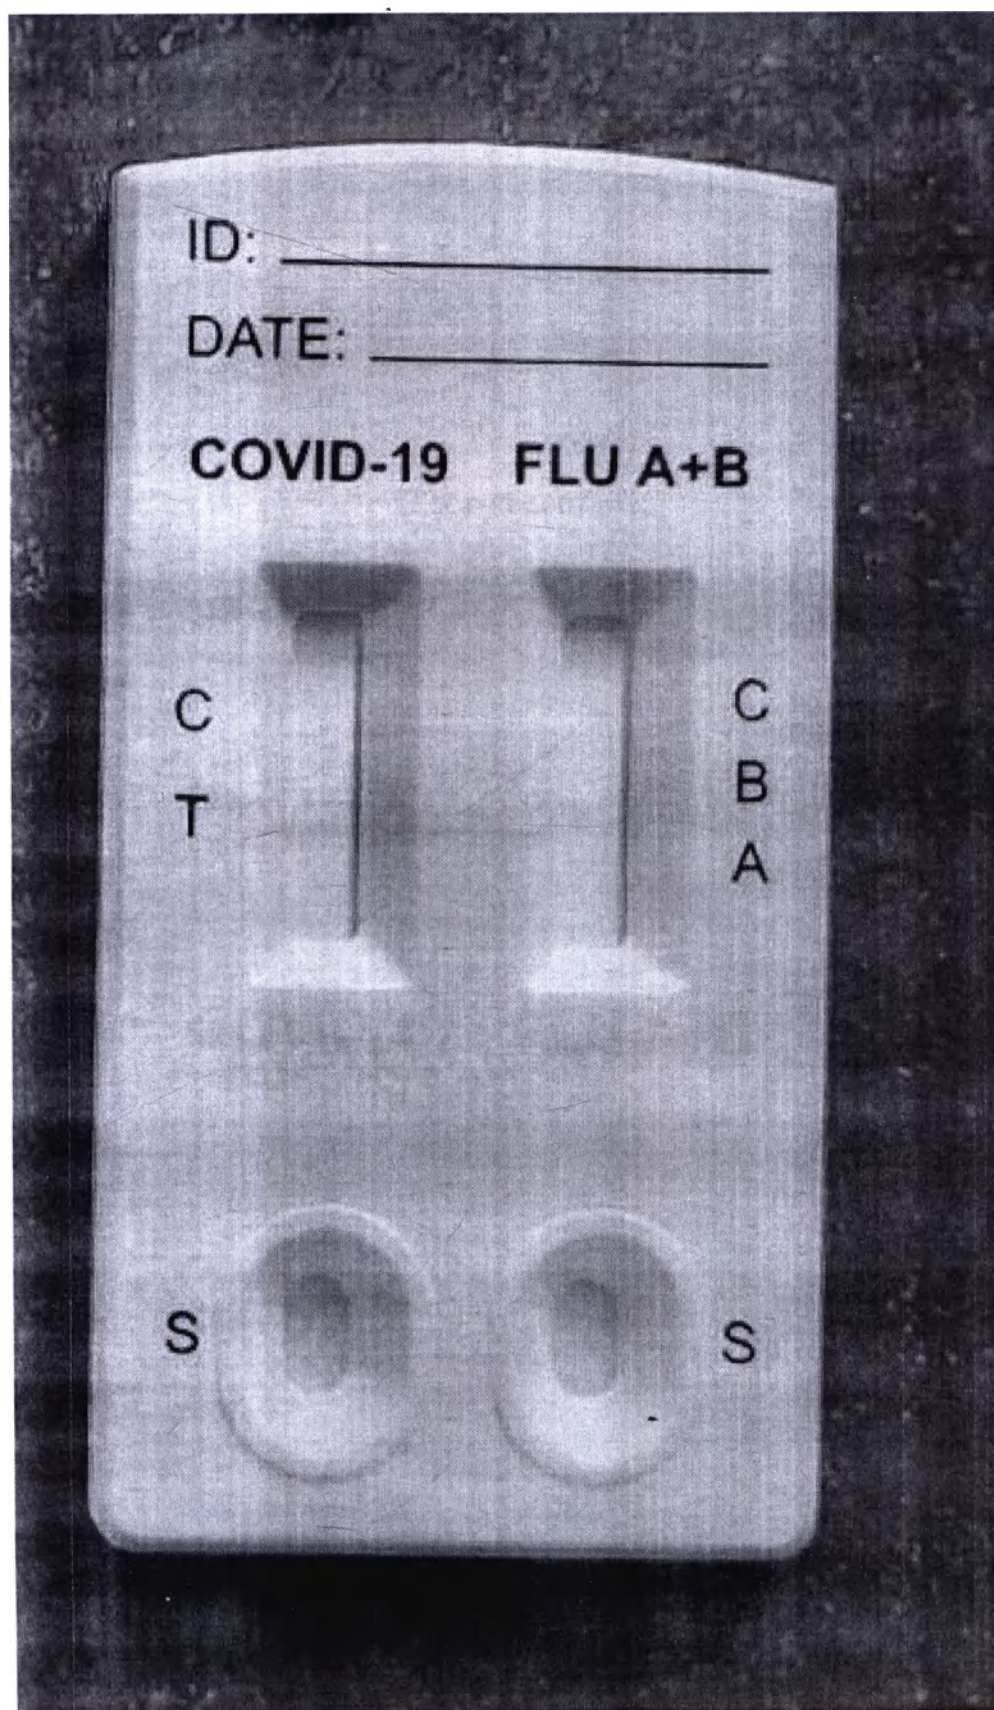



Стерильный тампон в индивидуальной упаковке (сторона 2)

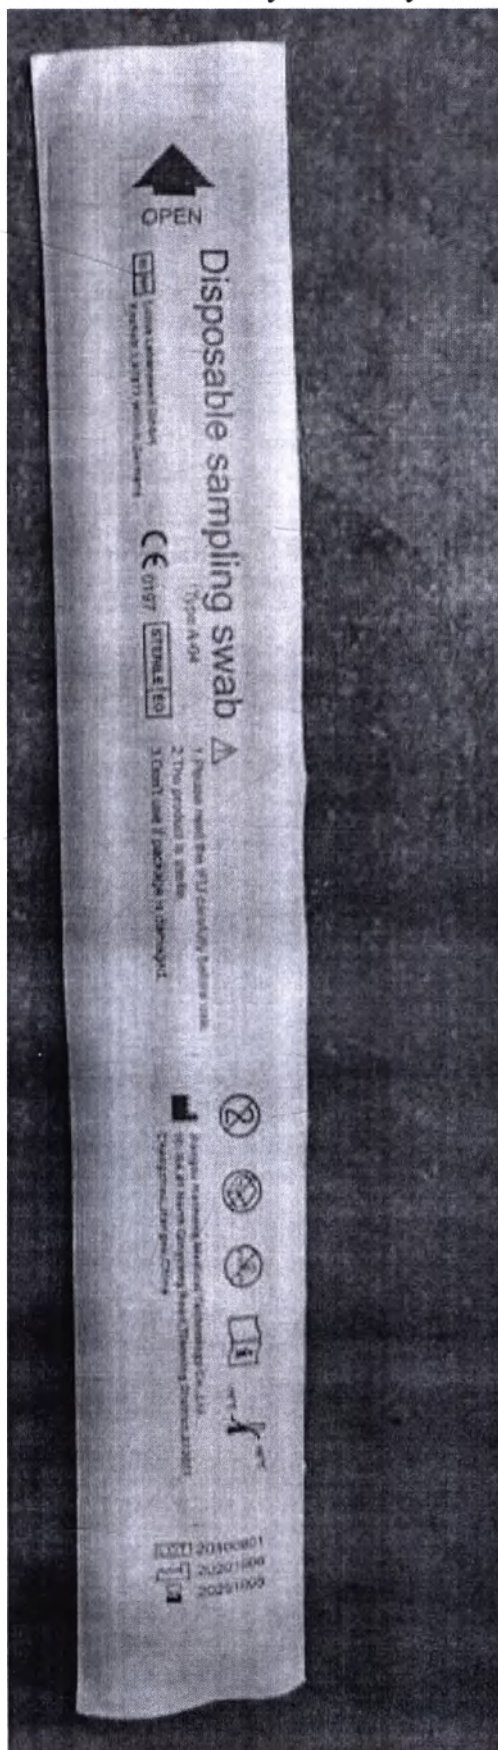


Буфер

(в первичной упаковке и ПЭ пакете)

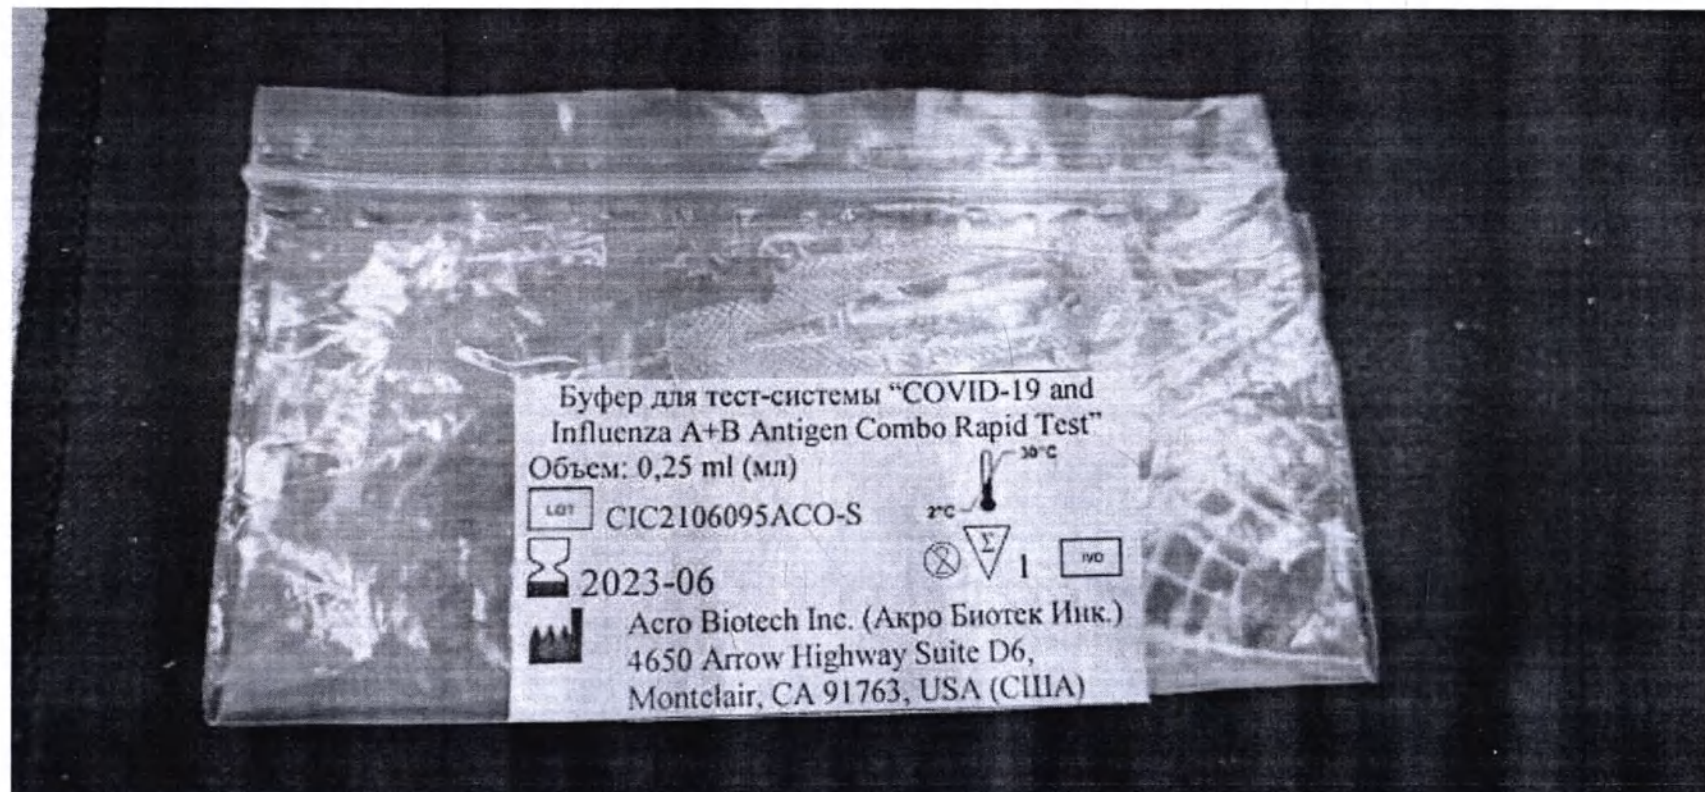

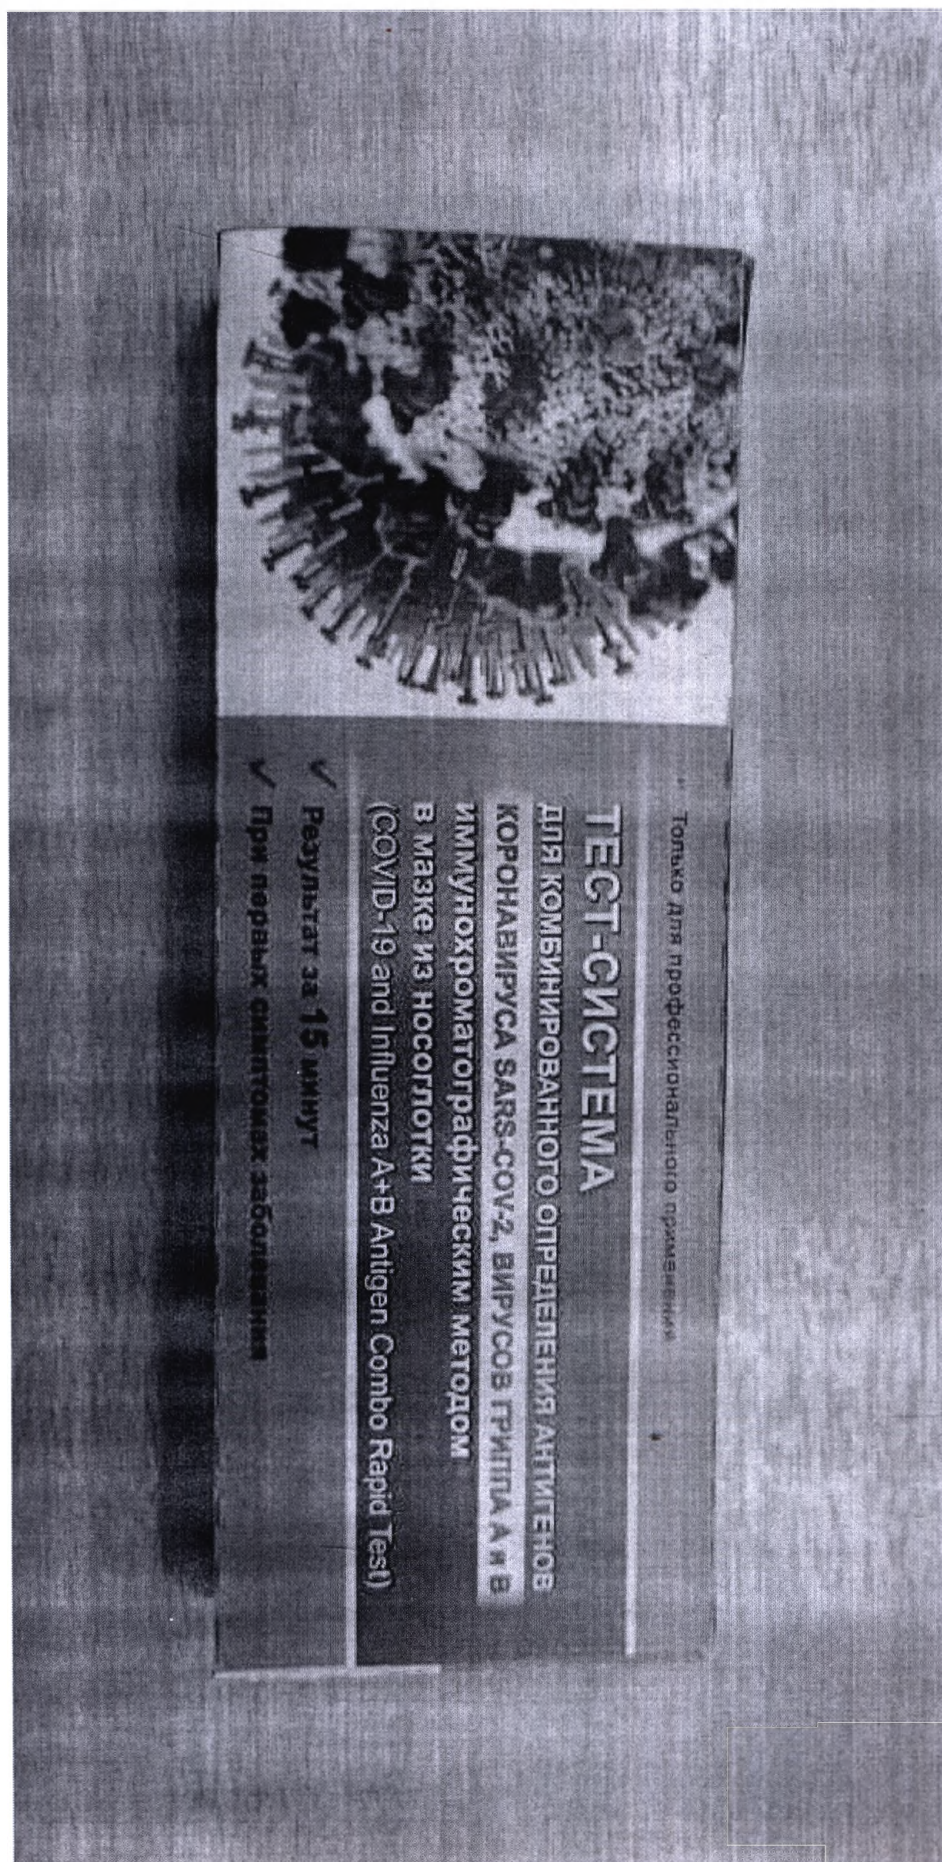

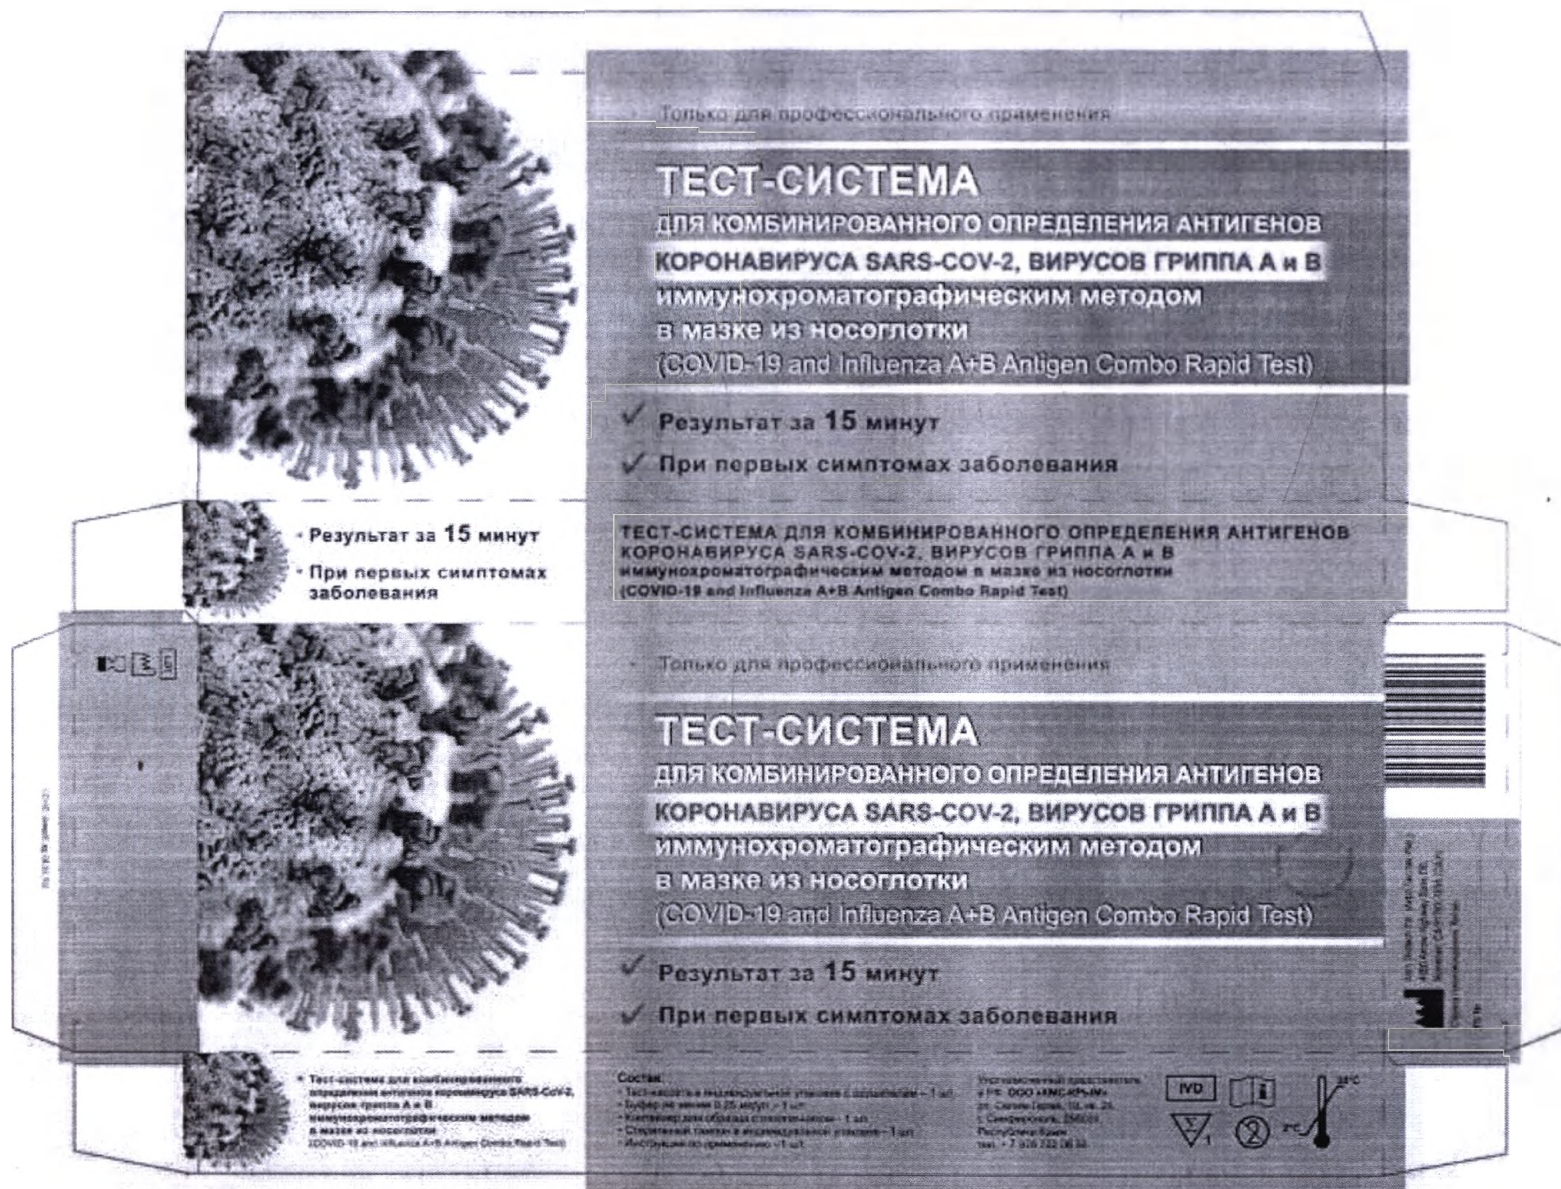

Макет этикетки первичной упаковки тест-кассеты

Тест-система для комбинированного определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А и В иммунохроматографическим методом в мазке из носоглотки (COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test):
Тест-кассета в индивидуальной упаковке с осушителем

Макет маркировки буфера

Буфер для тест-системы "COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test"

Объем: 0,25 ml (мл)



 XXXX-XX

 Acro Biotech Inc. (Акро Биотек Инк.)
4650 Arrow Highway Suite D6,
Montclair, CA 91763, USA (США)

Примечание. Ввиду малого информационного поля тубик-капельницы маркировка наносится на ПЭ пакет, в который помещается тубик-капельница с буфером.

Всего пронумеровано, сшито и
Скреплено печатью 8 (восемь) листов
Директор ООО КМС-Крым
Петренко Э.М.

