


Образцы маркировки

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина в моче для ранней диагностики беременности «ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-169-41390295-2022 Комплект № 1

Место производства: Россия, 630559, Новосибирская область, г.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7
Юридический адрес: Россия, 630559, Новосибирская обл., г.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2
г.п. Колыцово, ул. Садовая, дом 2/7, этаж 2, помещение 2
8 (383) 209-34-54, 8-800-600-90-70, info@imbian.ru
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

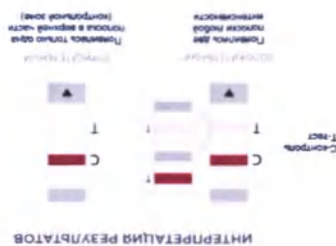

СОСТАВ НАБОРА:

Тест-полоска 1 шт.

Инструкция по применению 1 шт.

Для информирования специалистов
для профессионального применения
Не закрывать

LOT

REF



Женская линия
ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Женская линия
ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина в моче для ранней диагностики беременности «ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-169-41390295-2022
Комплект №1



1 TEST
Для диагностики in vitro



REF WR-008/1

ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



IVD

2°C



30°C

Комплект № 2

Место производства: Россия, Новосибирская область, г.п. Кончово, ул. Садовая, д. 2/7
 Юридический адрес: Россия 630559, Новосибирская обл., г.п. Кончово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2
 г.п. Кончово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2
 8 (383) 209-34-54, 8-800-600-80-77 info@imbian.ru
 ООО "ИМБИАН ЛАБ"



Для использования в профессиональных лабораториях
 Не закрывать



СОСТАВ НАБОРА:
 Тест-полоска 1 шт.
 Инструкция по применению 1 шт.



Женская линия
 ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Женская линия
 ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического
 определения хорионического гонадотропина в моче
 для ранней диагностики беременности «ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по
 ТУ 21.20.23-189-41380295-2022
 Комплект №2



3 ТЕСТА
 Для диагностики in vitro



REF WR-008/3

ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт

LOT XXXXXX




ГГГГ-ММ-ДД



IVD

2°C 30°C

Место производства: Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7
Юридический адрес: Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2
8 (383) 209-34-54, 8-800-600-90-77, info@imbian.ru
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

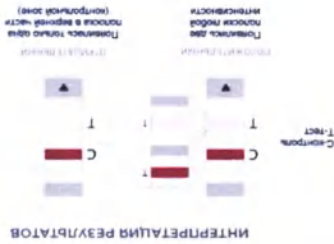

СОСТАВ НАБОРА:
Тест-полоска 1 шт.
Инструкция по применению 3 шт.

Для использования:
Для профессионального применения
Не заворачивать



Женская линия
ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Женская линия
ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина в моче
определения хорионического гонадотропина в моче
для ранней диагностики беременности «ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-169-41390295-2022
Комплект №2



3 ТЕСТА
Для диагностики in vivo



REF WR-008/3

ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



IVD

2°C - 30°C

Комплект № 4

Образец боковой этикетки



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2



Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7



8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp:
+73832093454

Образец основной этикетки

ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Набор содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Инструкция по применению

25 шт

1 шт

LOT XXXXXX
REF WR-008/25
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД



Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения
Не замораживать



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 25 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



2°C 30°C



Комплект № 5

Образец боковой этикетки



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2



Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7



8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp:
+73832093454

Образец основной этикетки

ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №5


Набор содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Инструкция по применению

50 шт

1 шт

LOT XXXXXX
REF WR-008/50
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД



Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения
Не замораживать



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 50 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



2°C 30°C



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

«*24*» *05* 2022 г.



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 лист 16

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

" 6 " 2022 г



Фотографические изображения общего вида

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина в моче для ранней диагностики беременности «ХГЧ- ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-169-41390295-2022 Комплект №1



Комплект №2



ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Экспресс-тест для
качественного
иммунохроматографического
определения хорионического
гонадотропина в моче для
ранней диагностики
беременности
«ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-169-41390295-
2022

Назначение
Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического
определения хорионического
гонадотропина в моче для ранней
диагностики беременности «ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-
169-41390295-2022. Набор
реагентов предназначена для in
vivo быстрого одноэтапного
качественного определения
хорионического гонадотропина
человека (ХГЧ) в моче методом
иммунохроматографического
анализа для ранней диагностики
беременности.

Функциональное назначение:
Тест предназначен для
использования специалистами в
области здравоохранения в



Комплект №3




ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Экспресс-тест для
качественного
иммунохроматографического
определения хорионического
гонадотропина в моче для
ранней диагностики
беременности
«ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-169-41390295-
2022

Назначение
Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического
определения хорионического
гонадотропина в моче для ранней
диагностики беременности «ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-
169-41390295-2022. Набор
реагентов предназначен для in
vitro быстрого определения
качественного гонадотропина
хорионического человека (ХГЧ) в моче методом
иммунохроматографического
анализа для ранней диагностики
беременности.


Функциональное назначение:
Тест предназначен для
использования специалистами в
области гинекологии.



Комплект №4

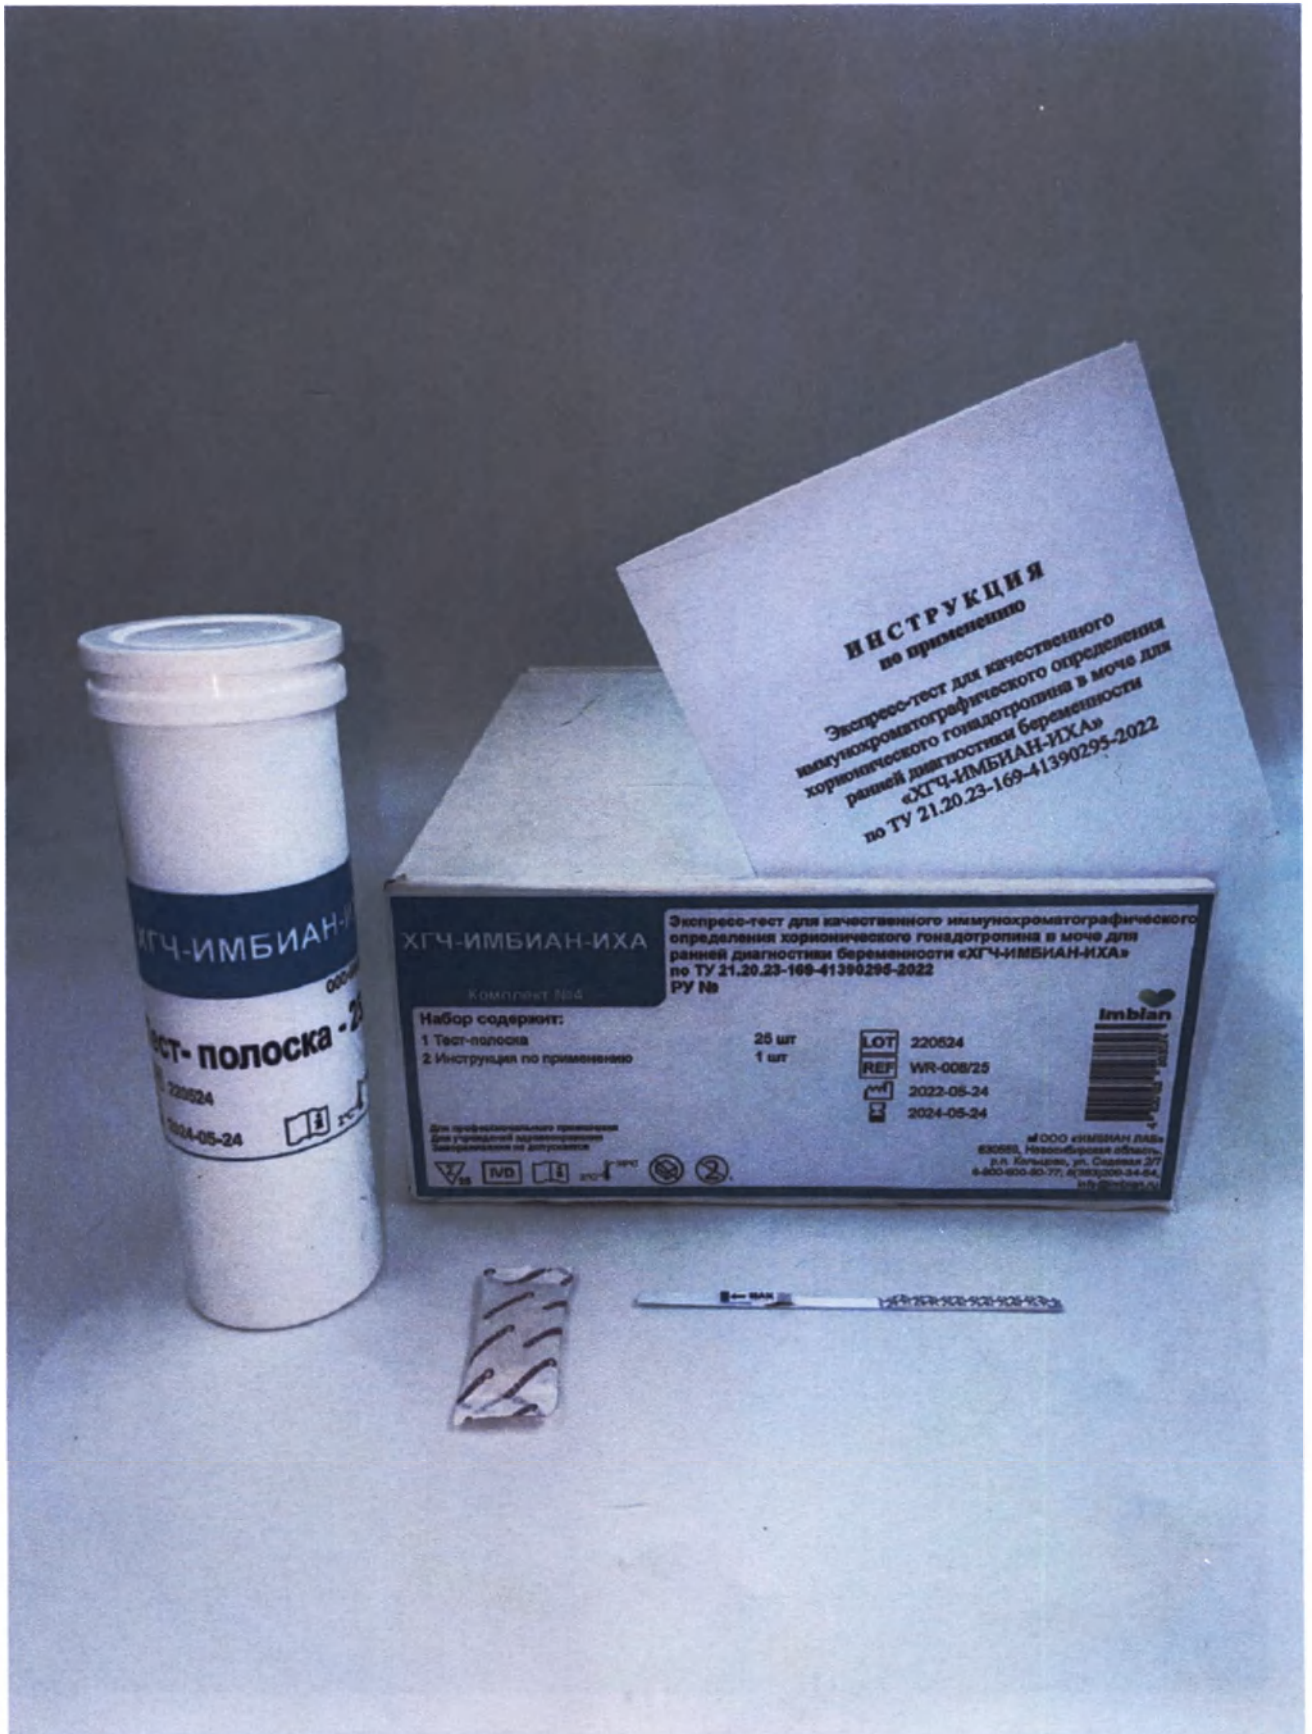

Комплект №5

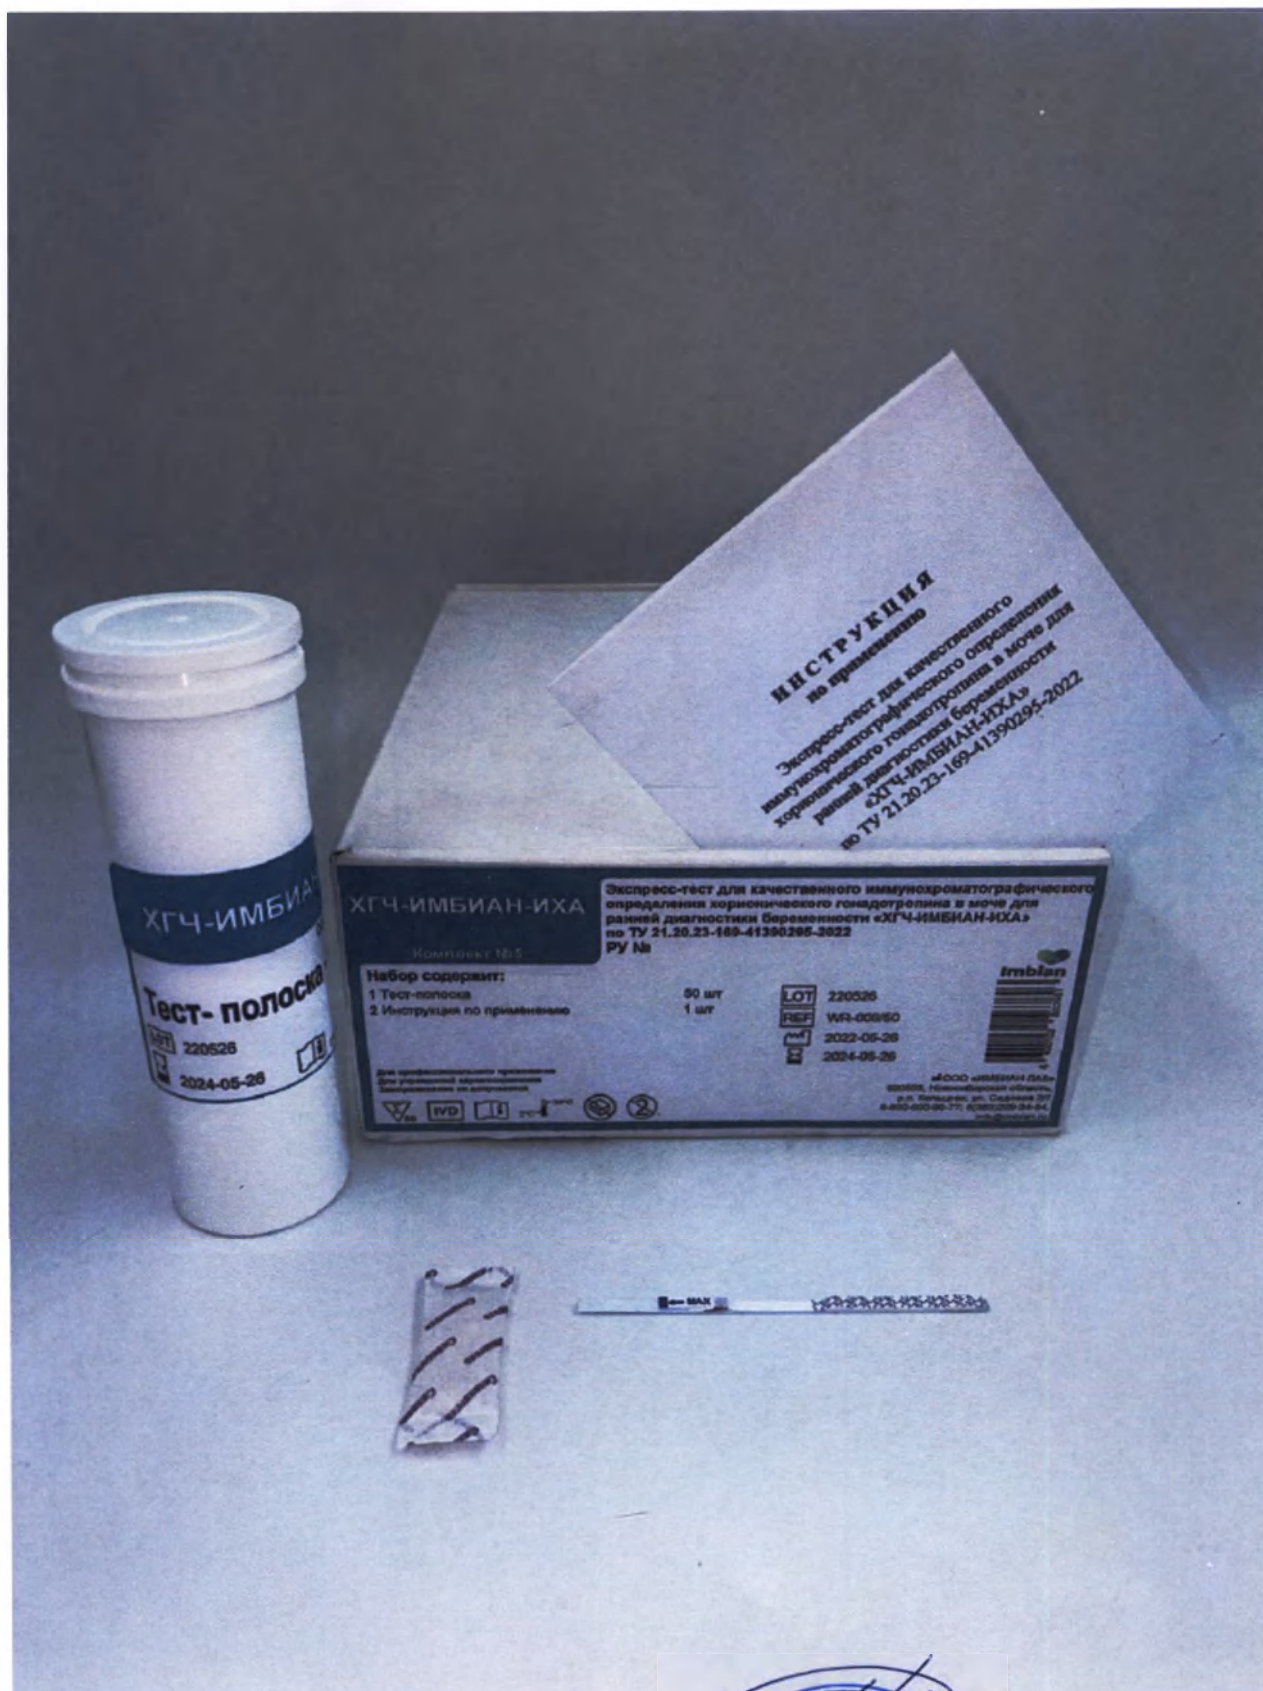

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«24» 05 2022 г.



1

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 Л. СТ. 26
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипова
2022 г.

