


МАКЕТЫ РУССКОЯЗЫЧНОЙ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

Супервайзер по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»

 Горбенко Е.А.

М.П.



REF 2210

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм,
дренирующие каналы на 3/4 длины (2210), 10 шт.
в уп. с инструкцией по применению, в составе:

- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм,
дренирующие каналы на 3/4 длины;
- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °C

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2211

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм,
дренирующие каналы на всю длину (2211), 10 шт.

в уп. с инструкцией по применению, в составе:

- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм,
дренирующие каналы на всю длину;

- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °C

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

2212

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм,
дренирующие каналы на всю длину с троакаром
3/16 (2212), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению, в составе:

- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм,
дренирующие каналы на всю длину с троакаром
3/16;

- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2213

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм,
дренирующие каналы на 3/4 длины (2213), 10 шт.

в уп. с инструкцией по применению, в составе:

- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм,
дренирующие каналы на 3/4 длины;

- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

2214

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм,
дренирующие каналы на всю длину (2214), 10 шт.

в уп. с инструкцией по применению, в составе:

- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм,
дренирующие каналы на всю длину;
- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °C

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2215

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм,
дренирующие каналы на всю длину с троакаром
3/16 (2215), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению, в составе:

- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм,
дренирующие каналы на всю длину с троакаром
3/16;

- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2216

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм,
дренирующие каналы на 3/4 длины с троакаром
3/16 (2216), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению, в составе:

- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм,
дренирующие каналы на 3/4 длины с троакаром
3/16;

- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °C

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2217

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм,
дренирующие каналы на 3/4 длины с троакар 3/16 (2217), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению, в составе:

- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм,
дренирующие каналы на 3/4 длины с троакар 3/16;

- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °C

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

2226

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 10 Fr (2226), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению, в составе:

- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 10 Fr;
- Переходник 1/8.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

2227

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 10 Fr с троакаром 1/8 (2227), 10 шт. в уп. с
инструкцией по применению, в составе:

- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 10 Fr с троакаром 1/8;
- Переходник 1/8.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2228

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 15 Fr (2228), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению, в составе:

- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 15 Fr;

- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2229

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 15 Fr с троакаром 3/16 (2229), 10 шт. в уп.
с инструкцией по применению, в составе:

- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 15 Fr с троакаром 3/16;
- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °C

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2230

Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 19 Fr (2230), 10 шт. в уп. с инструкцией по применению, в составе:

- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 19 Fr;
- Переходник 1/4.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя, адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва, ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2231

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 19 Fr с троакаром 1/4 (2231), 10 шт. в уп. с
инструкцией по применению, в составе:

- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 19 Fr с троакаром 1/4;
- Переходник 1/4.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °C

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2232

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 19 Fг с гибким троакаром 1/4 (2232), 10 шт.

в уп. с инструкцией по применению, в составе:

- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 19 Fг с гибким троакаром 1/4;
- Переходник 1/4.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

2233

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 15 Fr с гибким троакаром 3/16 (2233), 10
шт. в уп. с инструкцией по применению, в
составе:

- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 15 Fr с гибким троакаром 3/16;
- Переходник 3/16.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °C

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2234

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 24 Fr (2234), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению, в составе:

- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый
Blake, 24 Fr;
- Переходник 1/4.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

2160

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Резервуар для дренирования J-Vac, круглый,
100 мл (2160), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

2161

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Резервуар для дренирования J-Vac, плоский,
150 мл (2161), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

2163

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Резервуар для дренирования J-Vac, плоский,
300 мл (2163), 10 шт. в уп. с инструкцией по
применению

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF 2162

Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

Резервуар для дренирования J-Vac, плоский, 450 мл (2162), 10 шт. в уп. с инструкцией по применению

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя, адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва, ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 10 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °C

Не использовать после истечения срока годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

BCC1

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Кардиоконнектор Blake 1:1 (BCC1), 20 шт. в уп. с
инструкцией по применению

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 20 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

BCC2

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Кардиоконнектор Blake 2:1 (BCC2), 20 шт. в уп. с
инструкцией по применению

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 20 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки

REF

ВССЗ

Система для закрытого дренирования ран
Blake и J-Vac

Состав:

Кардиоконнектор Blake 3:1 (ВССЗ), 20 шт. в уп. с
инструкцией по применению

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение:

ФСЗ 2009/04566 от XX.XX.XXXX г.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва,
ул. Крылатская 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77

Количество штук в упаковке: 20 шт.

Использовать до: см. на упаковке.

Диапазон температур хранения: не более 30 °С

Не использовать после истечения срока
годности.

Место для технологического
штрих-кода этикетки



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

Супервайзер по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»


М.П.



Горбенко Е.А.

blake
Silicone Drains

10 x



REF 2210

Silicone Drain
7 mm flat, 3/4 fluted
2210.S073.A80012006.1

Drain en silicone
plat de 7 mm, cannelé aux 3/4

Tubo di drenaggio in silicone
Piatto da 7 mm, scanalato per 3/4

Silicone Drain
7 mm flat, 3/4 fluted

Drenaje de silicona
7 mm plano, 3/4 acanalado

Silikon Dren
7 mm düz, 3/4 oluklu.

Drenagem em Silicone
7 mm plano, 3/4 canelado

Silikon-Drainage
7 mm flach, 3/4 kannelliert

STERILE UNIT

CE MDP

Johnson & Johnson Medical Ltd.
Simpson Parkway
Kirkton Campus
Livingston
EH54 7AT
United Kingdom



Manufactured for:

ETHICON, INC.

a Johnson & Johnson company

Route 22 West, P.O. Box 151
Somerville, New Jersey 08876-0151
USA

1-877-ETHICON
+1-513-337-6928

© Ethicon, Inc. 2013 IR-Drugs-667 B(1)

Suction Drain Made in Israel
J-VAC Adapter Made in U.S.A.

CE 0086

PHT DEHP
DHP



STERILE R

1903850

J1903850



2024-02-18



(01)20705031003467



(17)240218(10)J1903850




(20)42

Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

1. Дренажи Blake силиконовые – плоские и круглые с каналами дренирующими, с троакарами и без в вариантах исполнения

Вторичная упаковка на примере Дренажа плоского, силиконового Blake, 7 мм, дренирующие каналы на 3/4 длины (2210), 10 шт. в уп.

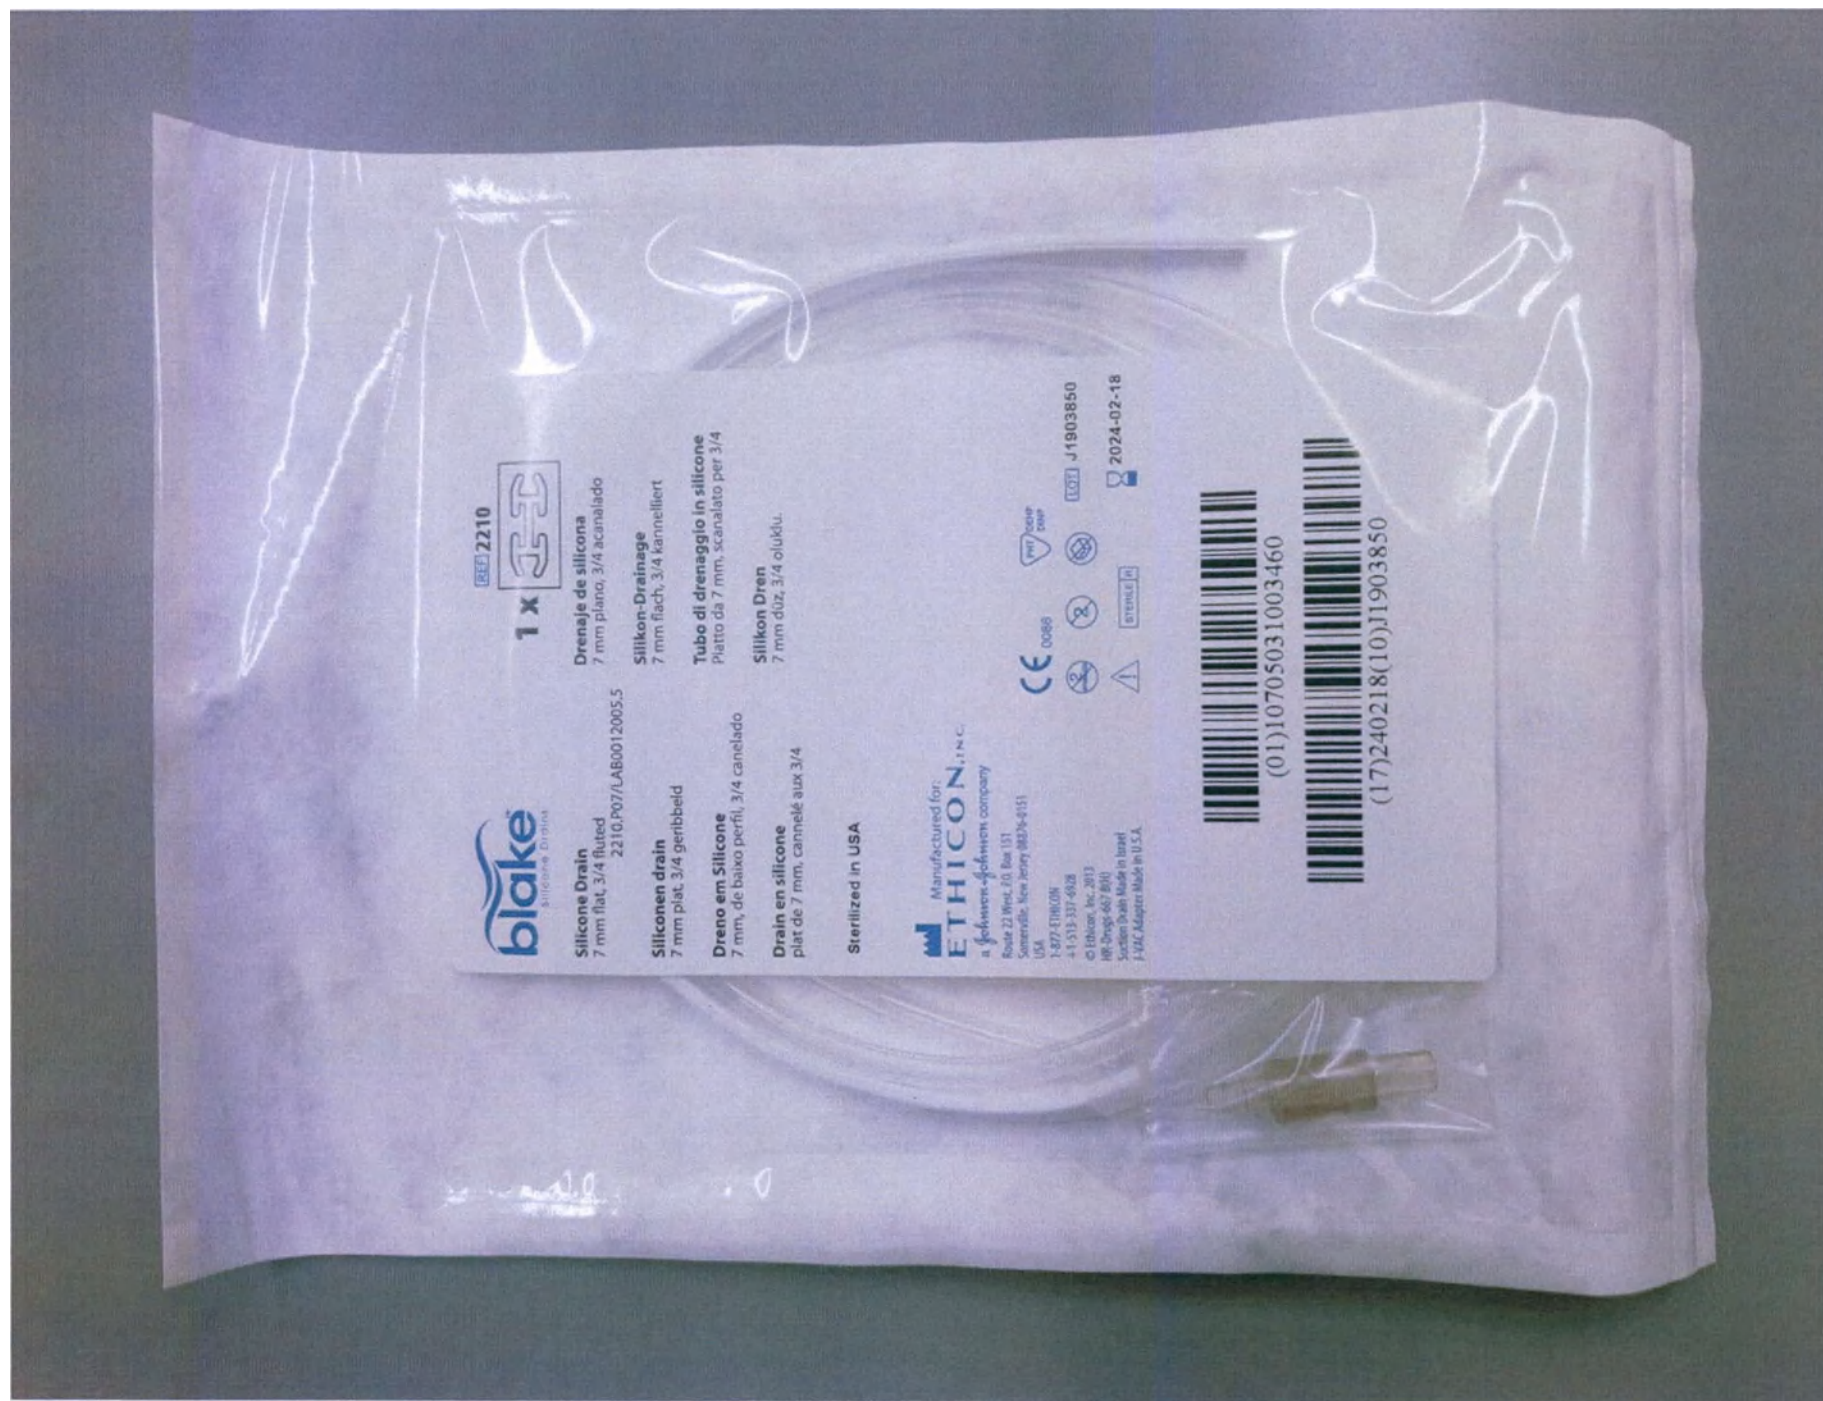


Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

1. Дренажи Blake силиконовые – плоские и круглые с каналами дренирующими, с троакарами и без в вариантах исполнения


Первичная упаковка на примере Дренажа плоского, силиконового Blake, 7 мм, дренирующие каналы на 3/4 длины (2210), 10 шт. в уп., в составе: -




Переходник 3/16

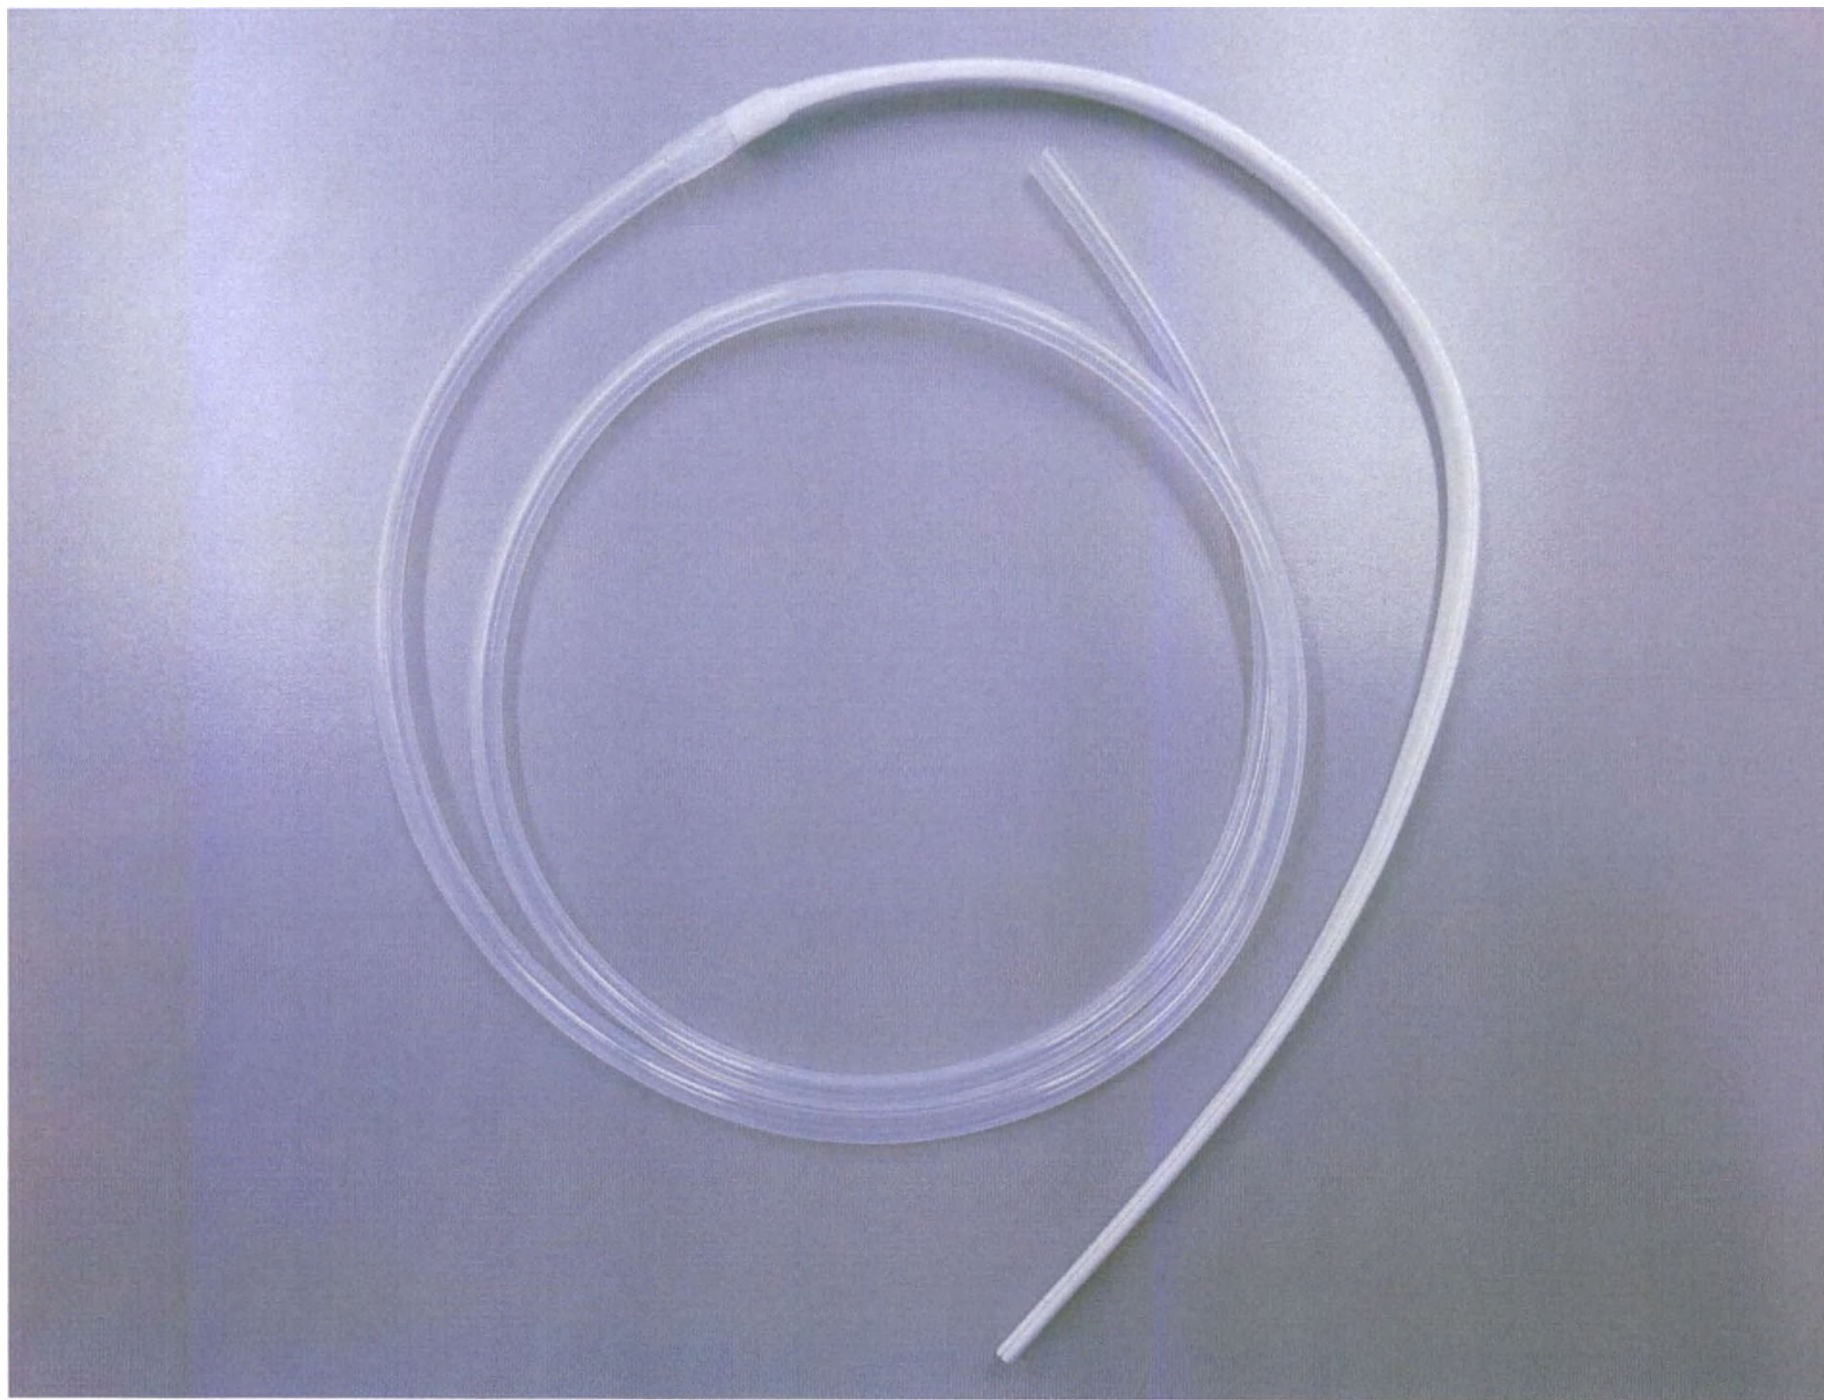


1.1. Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм, дренирующие каналы на 3/4 длины (2210), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм, дренирующие каналы на 3/4 длины;

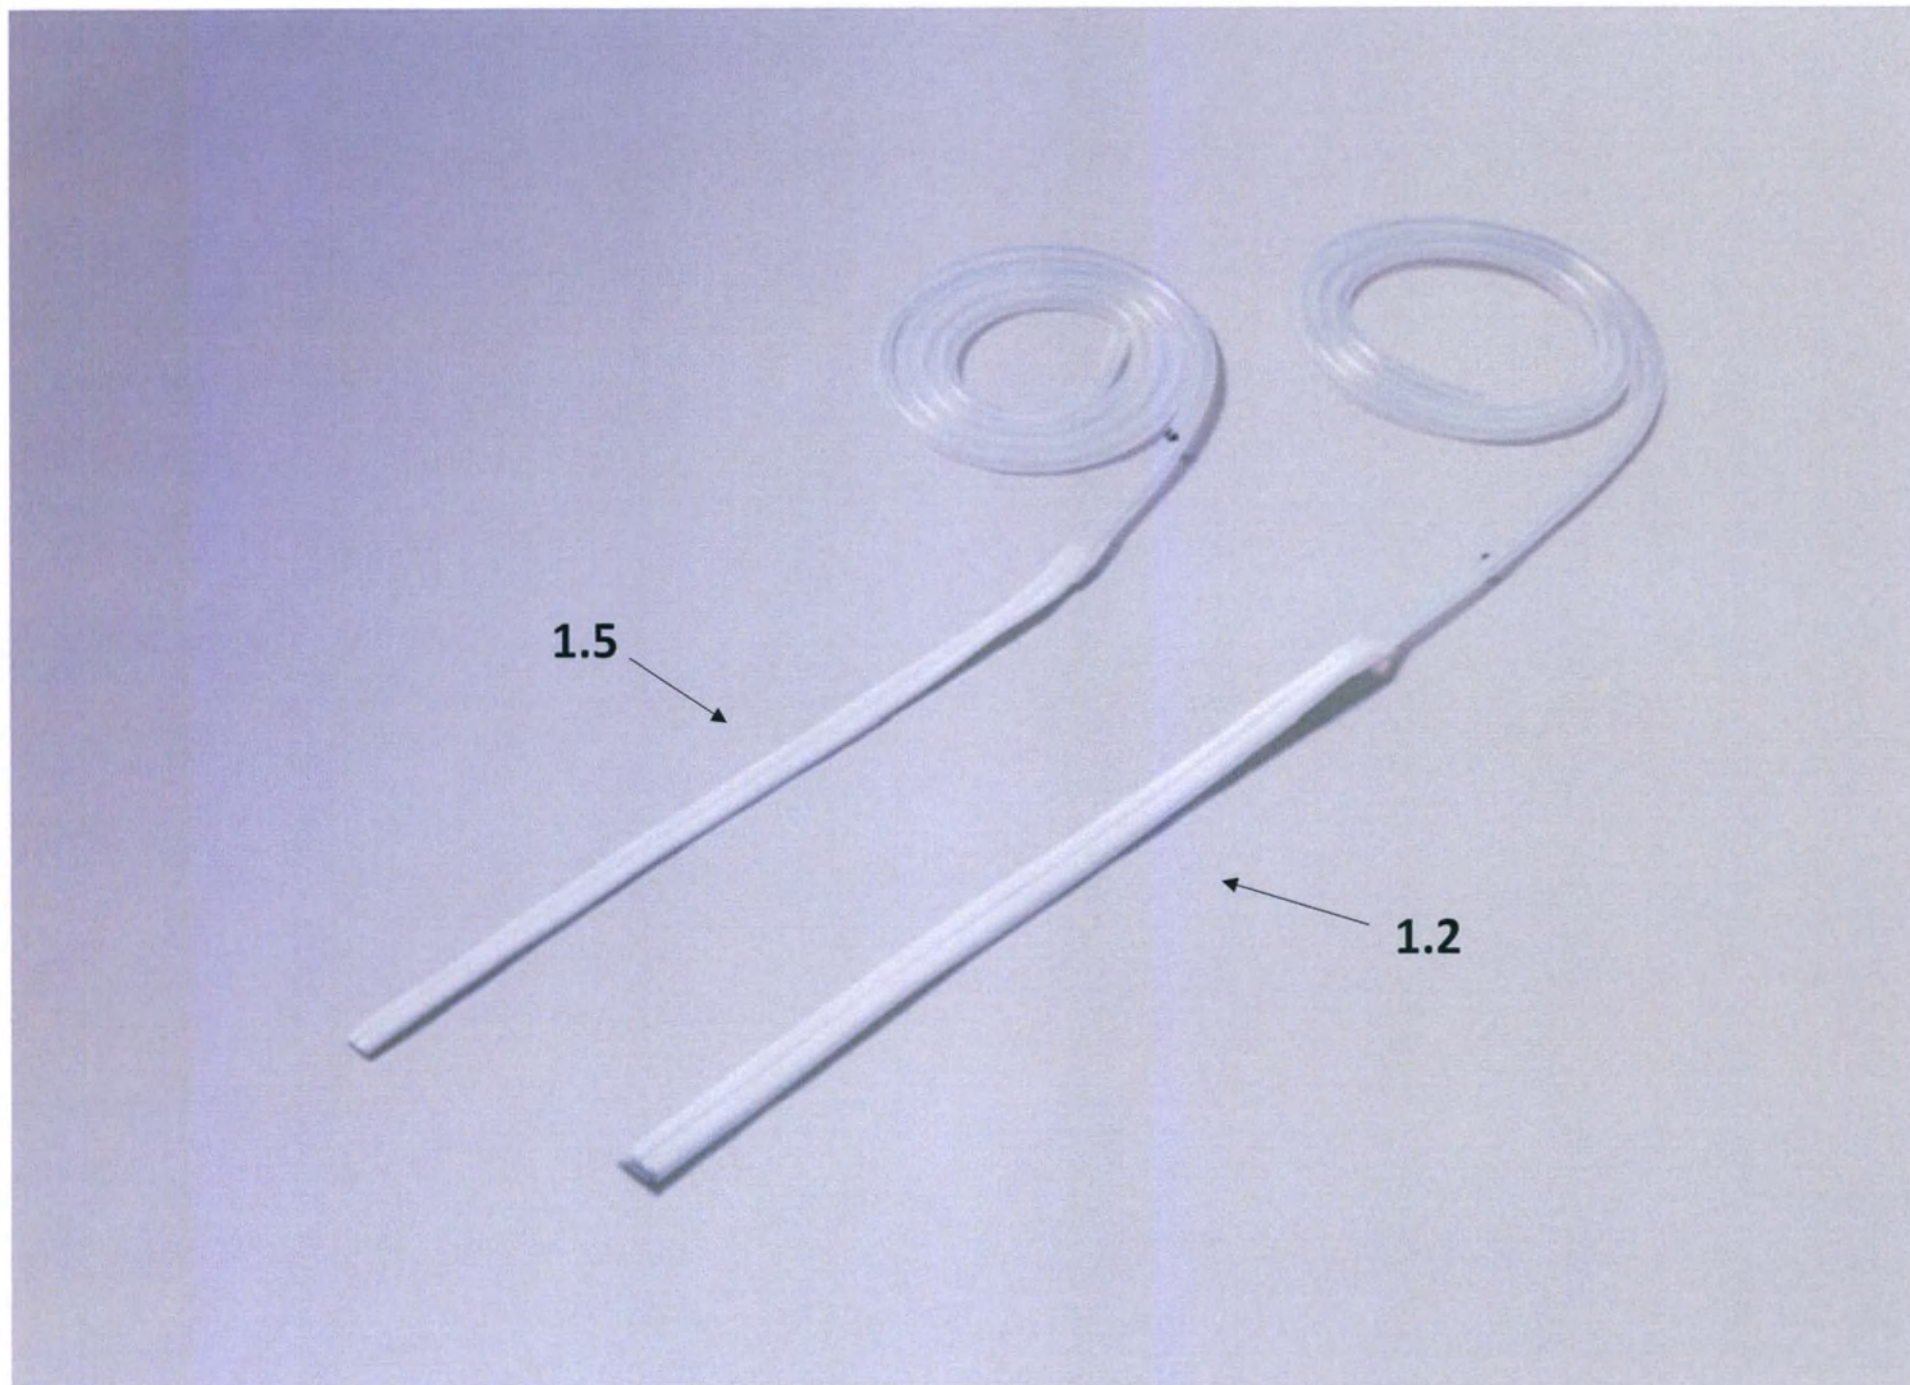


- 1.2. Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм, дренирующие каналы на всю длину (2211), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм, дренирующие каналы на всю длину;
- 1.5. Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм, дренирующие каналы на всю длину (2214), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм, дренирующие каналы на всю длину;

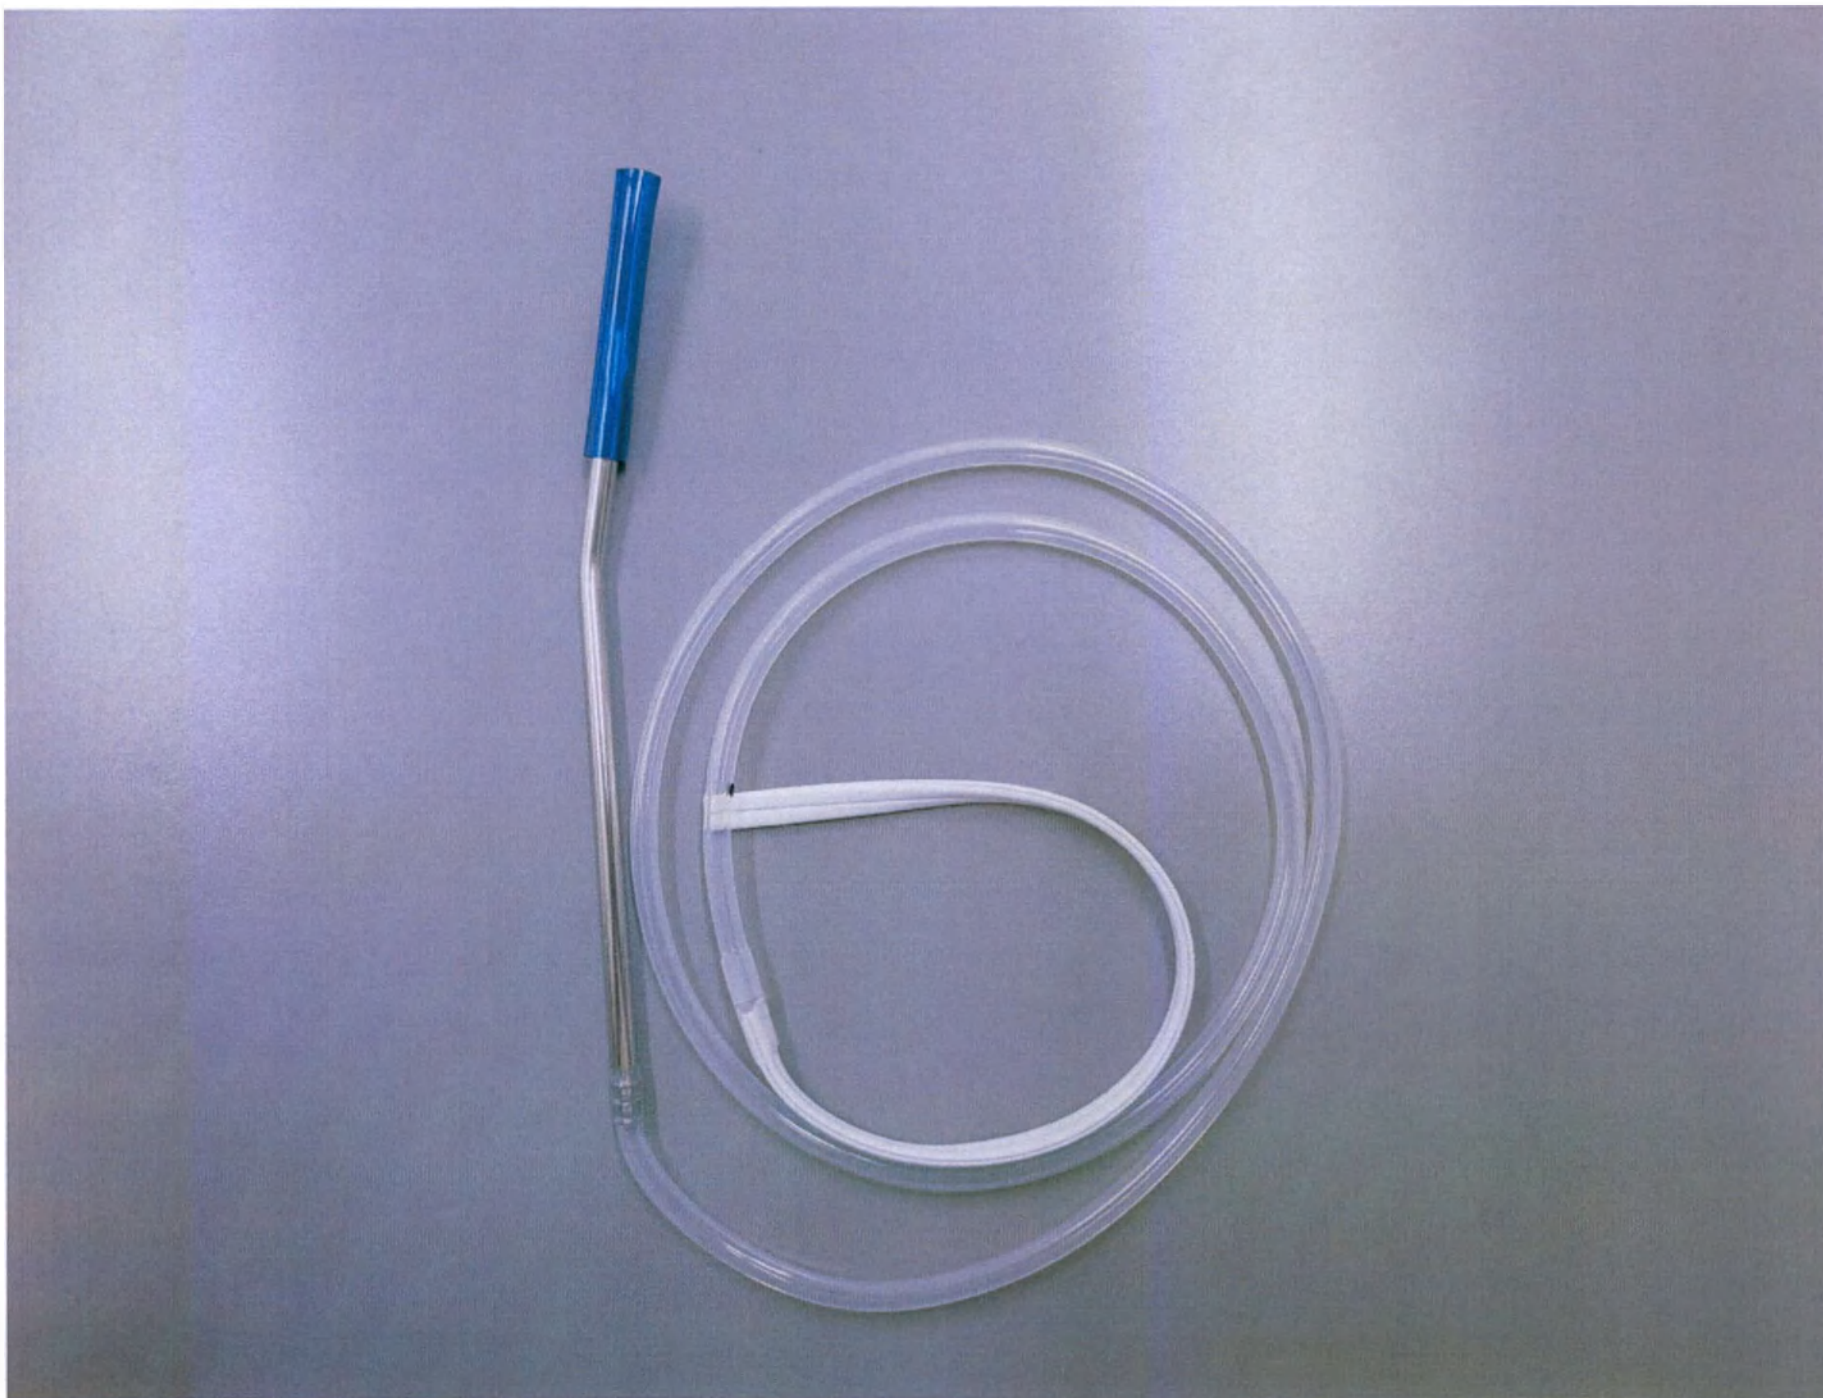


1.3. Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм, дренирующие каналы на всю длину с троакаром 3/16 (2212), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм, дренирующие каналы на всю длину с троакаром 3/16;

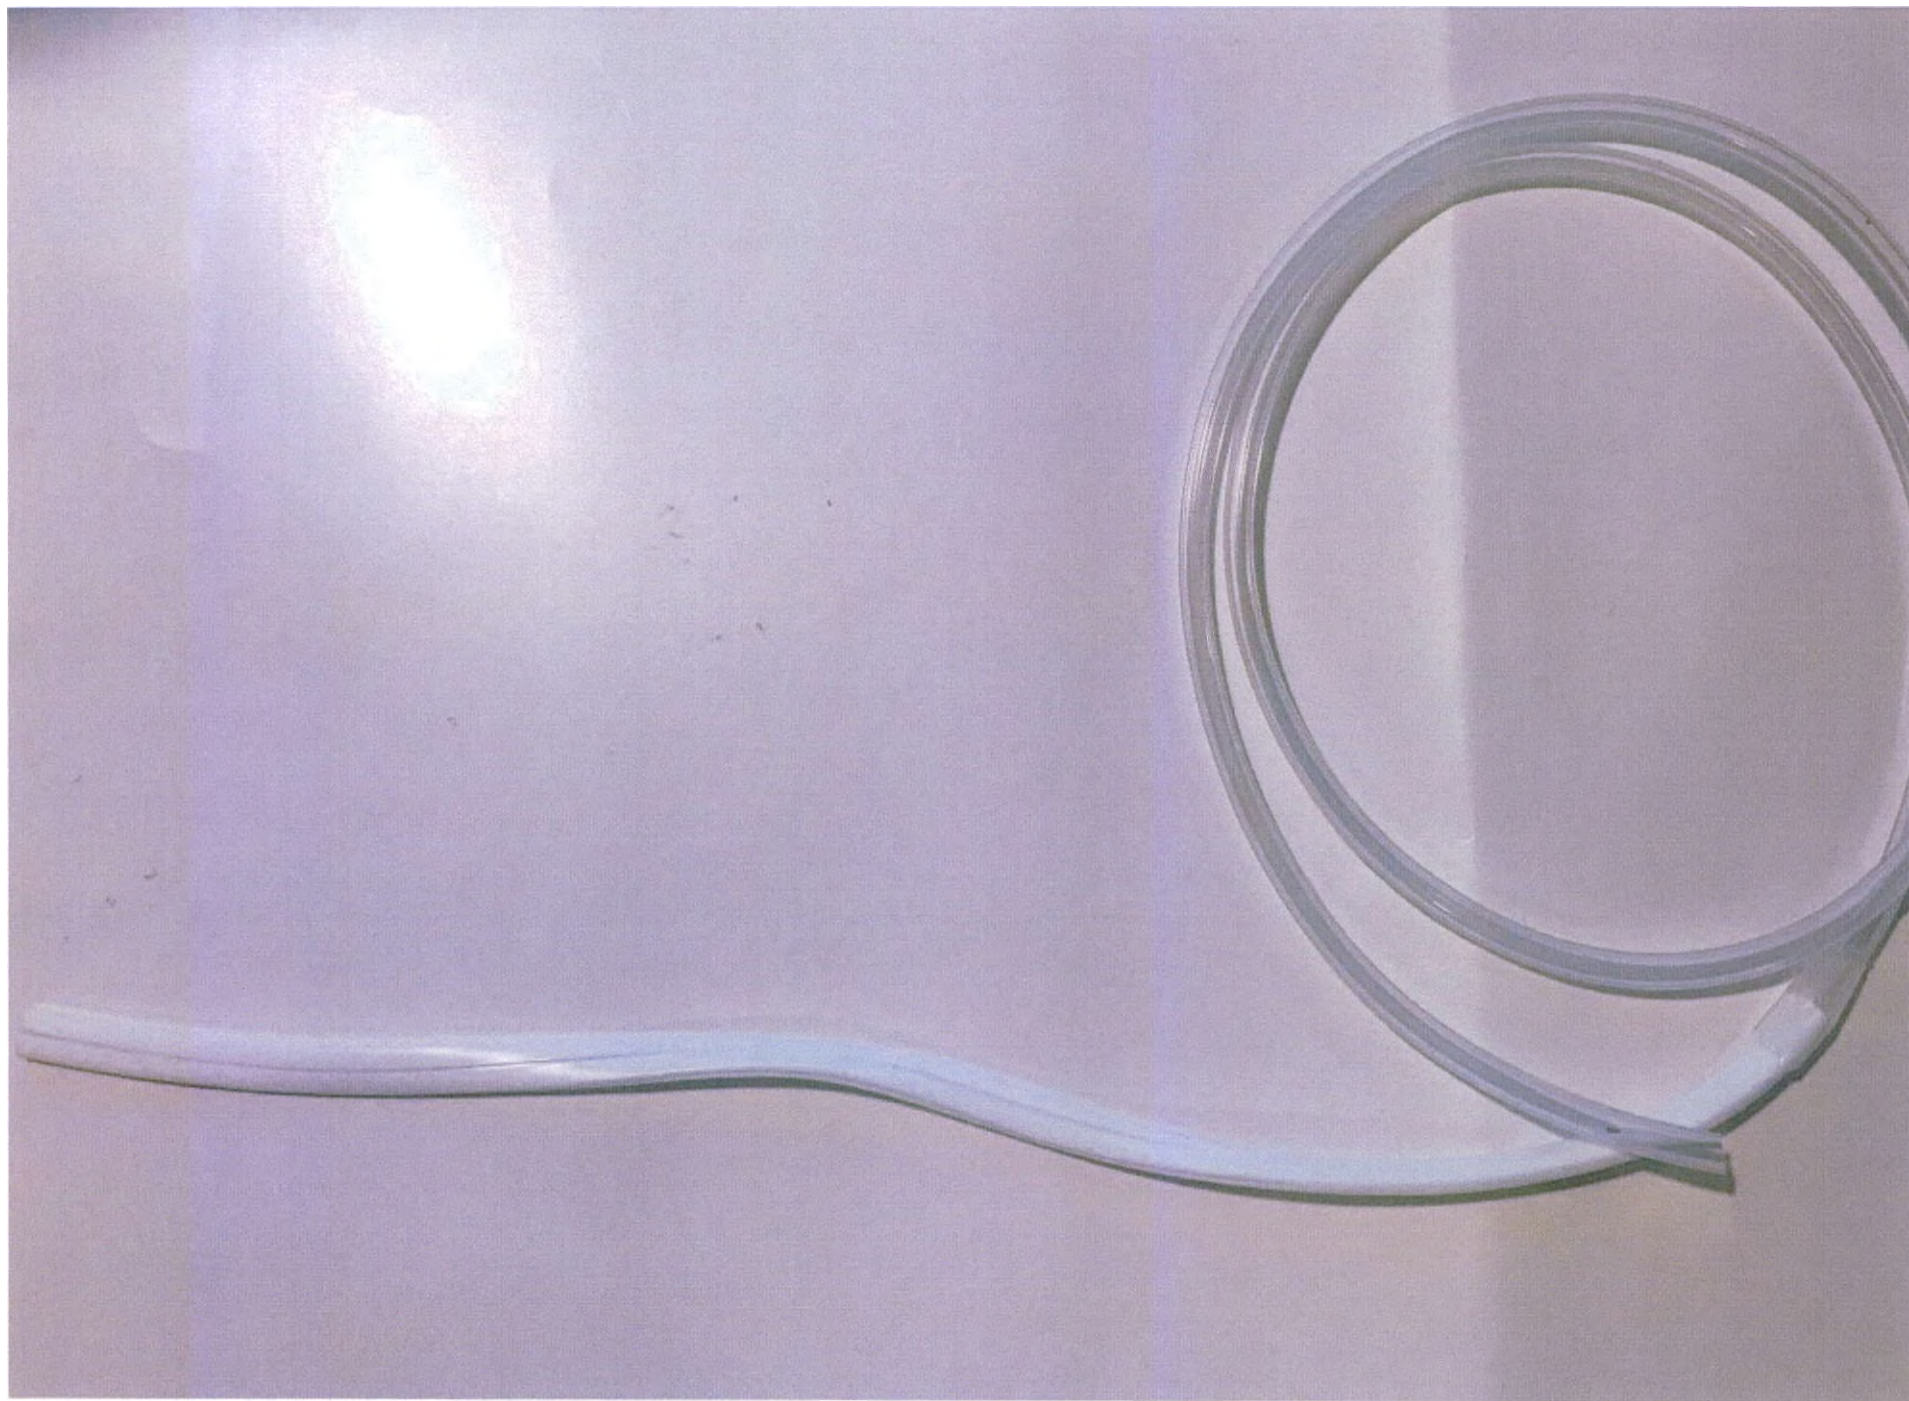


1.4. Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм, дренирующие каналы на 3/4 длины (2213), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм, дренирующие каналы на 3/4 длины;

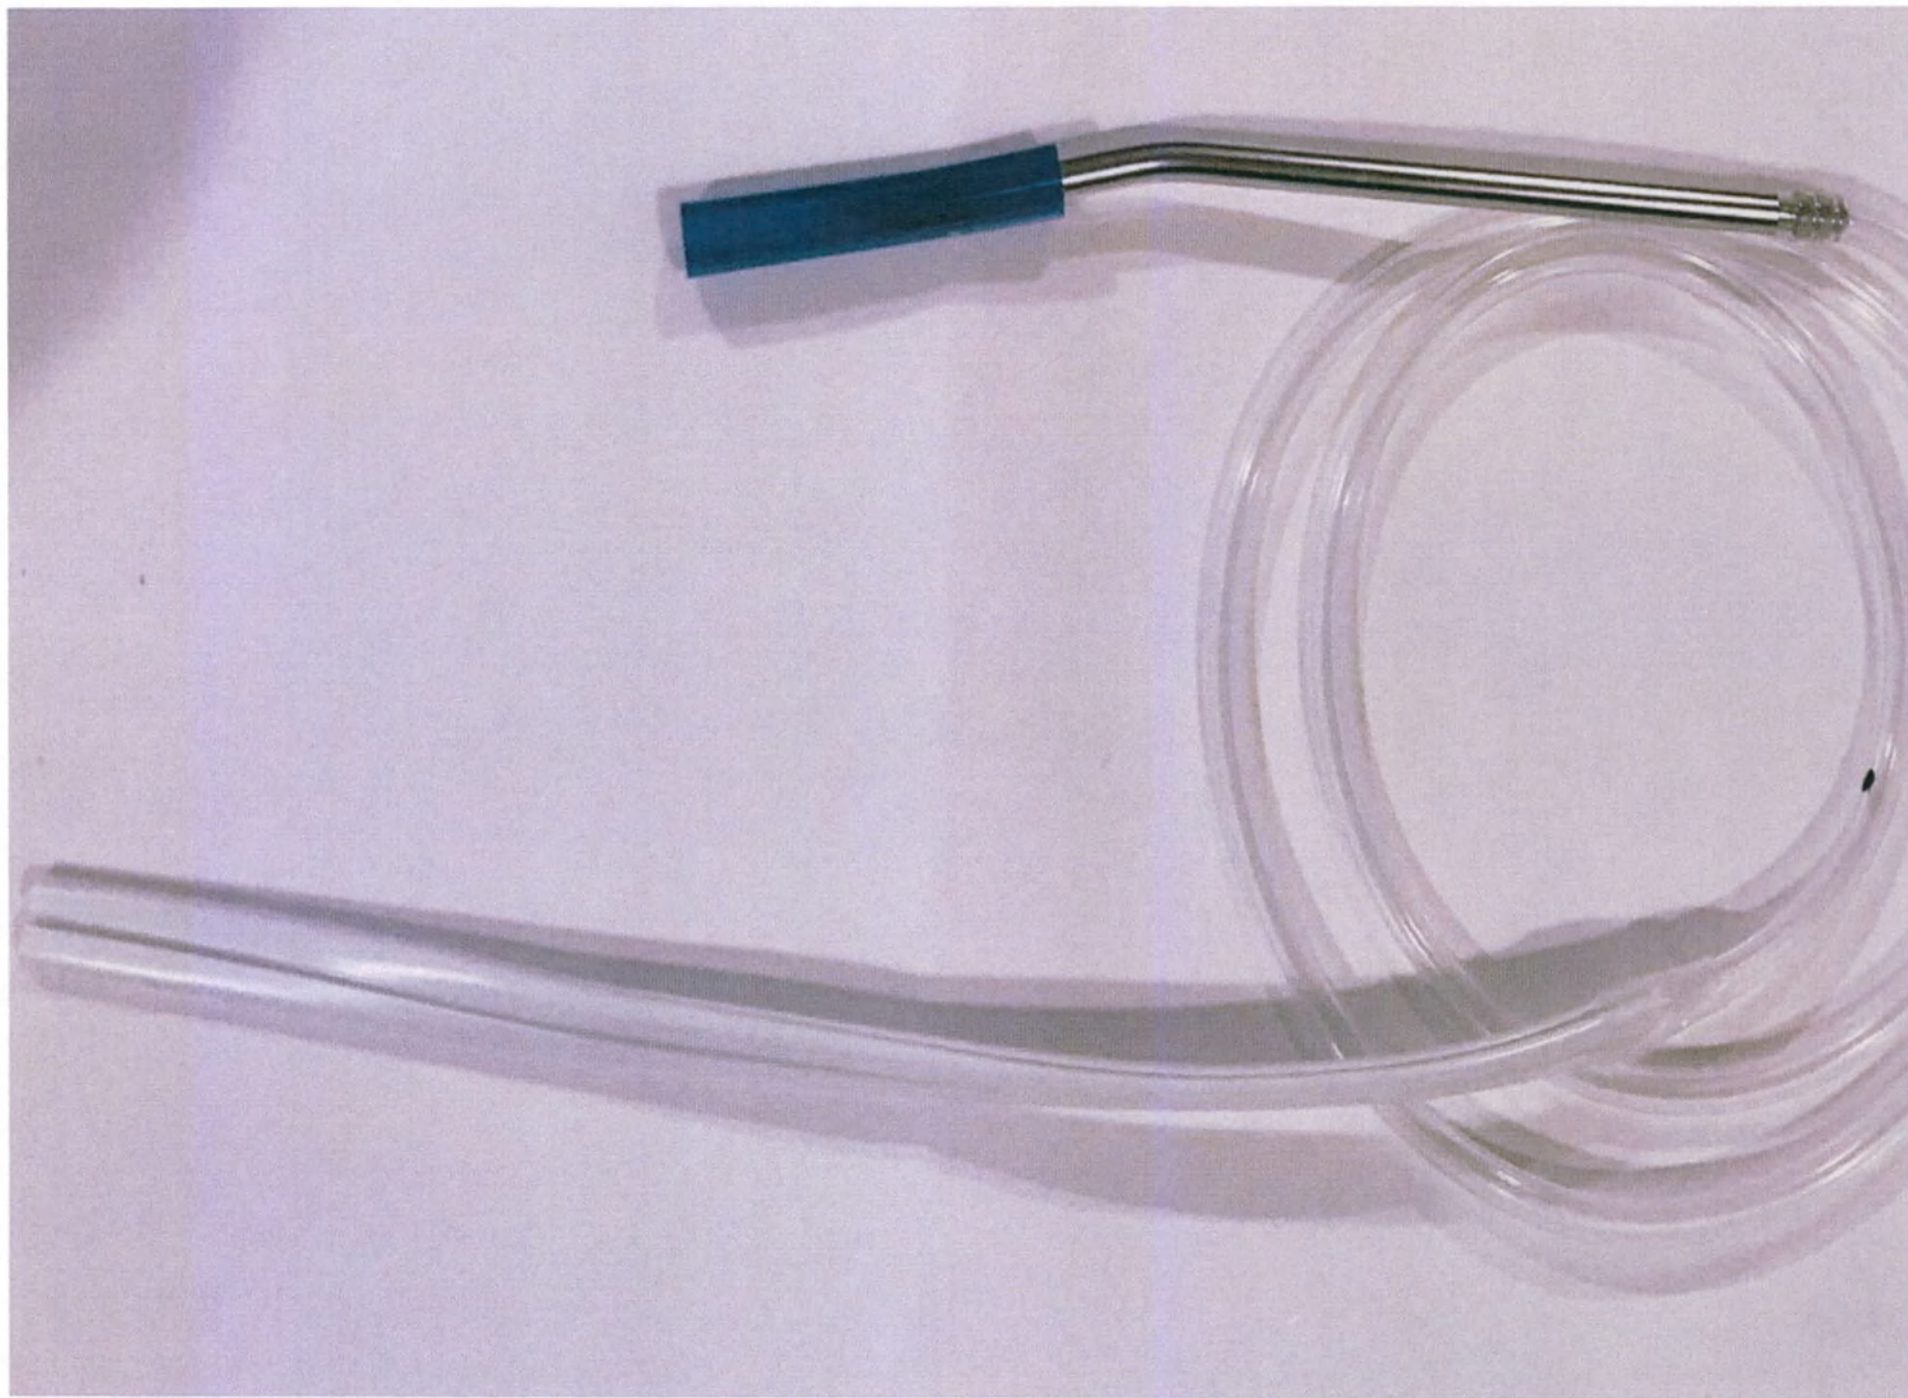

1.6. Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм, дренирующие каналы на всю длину с троакаром 3/16 (2215), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм, дренирующие каналы на всю длину с троакаром 3/16;

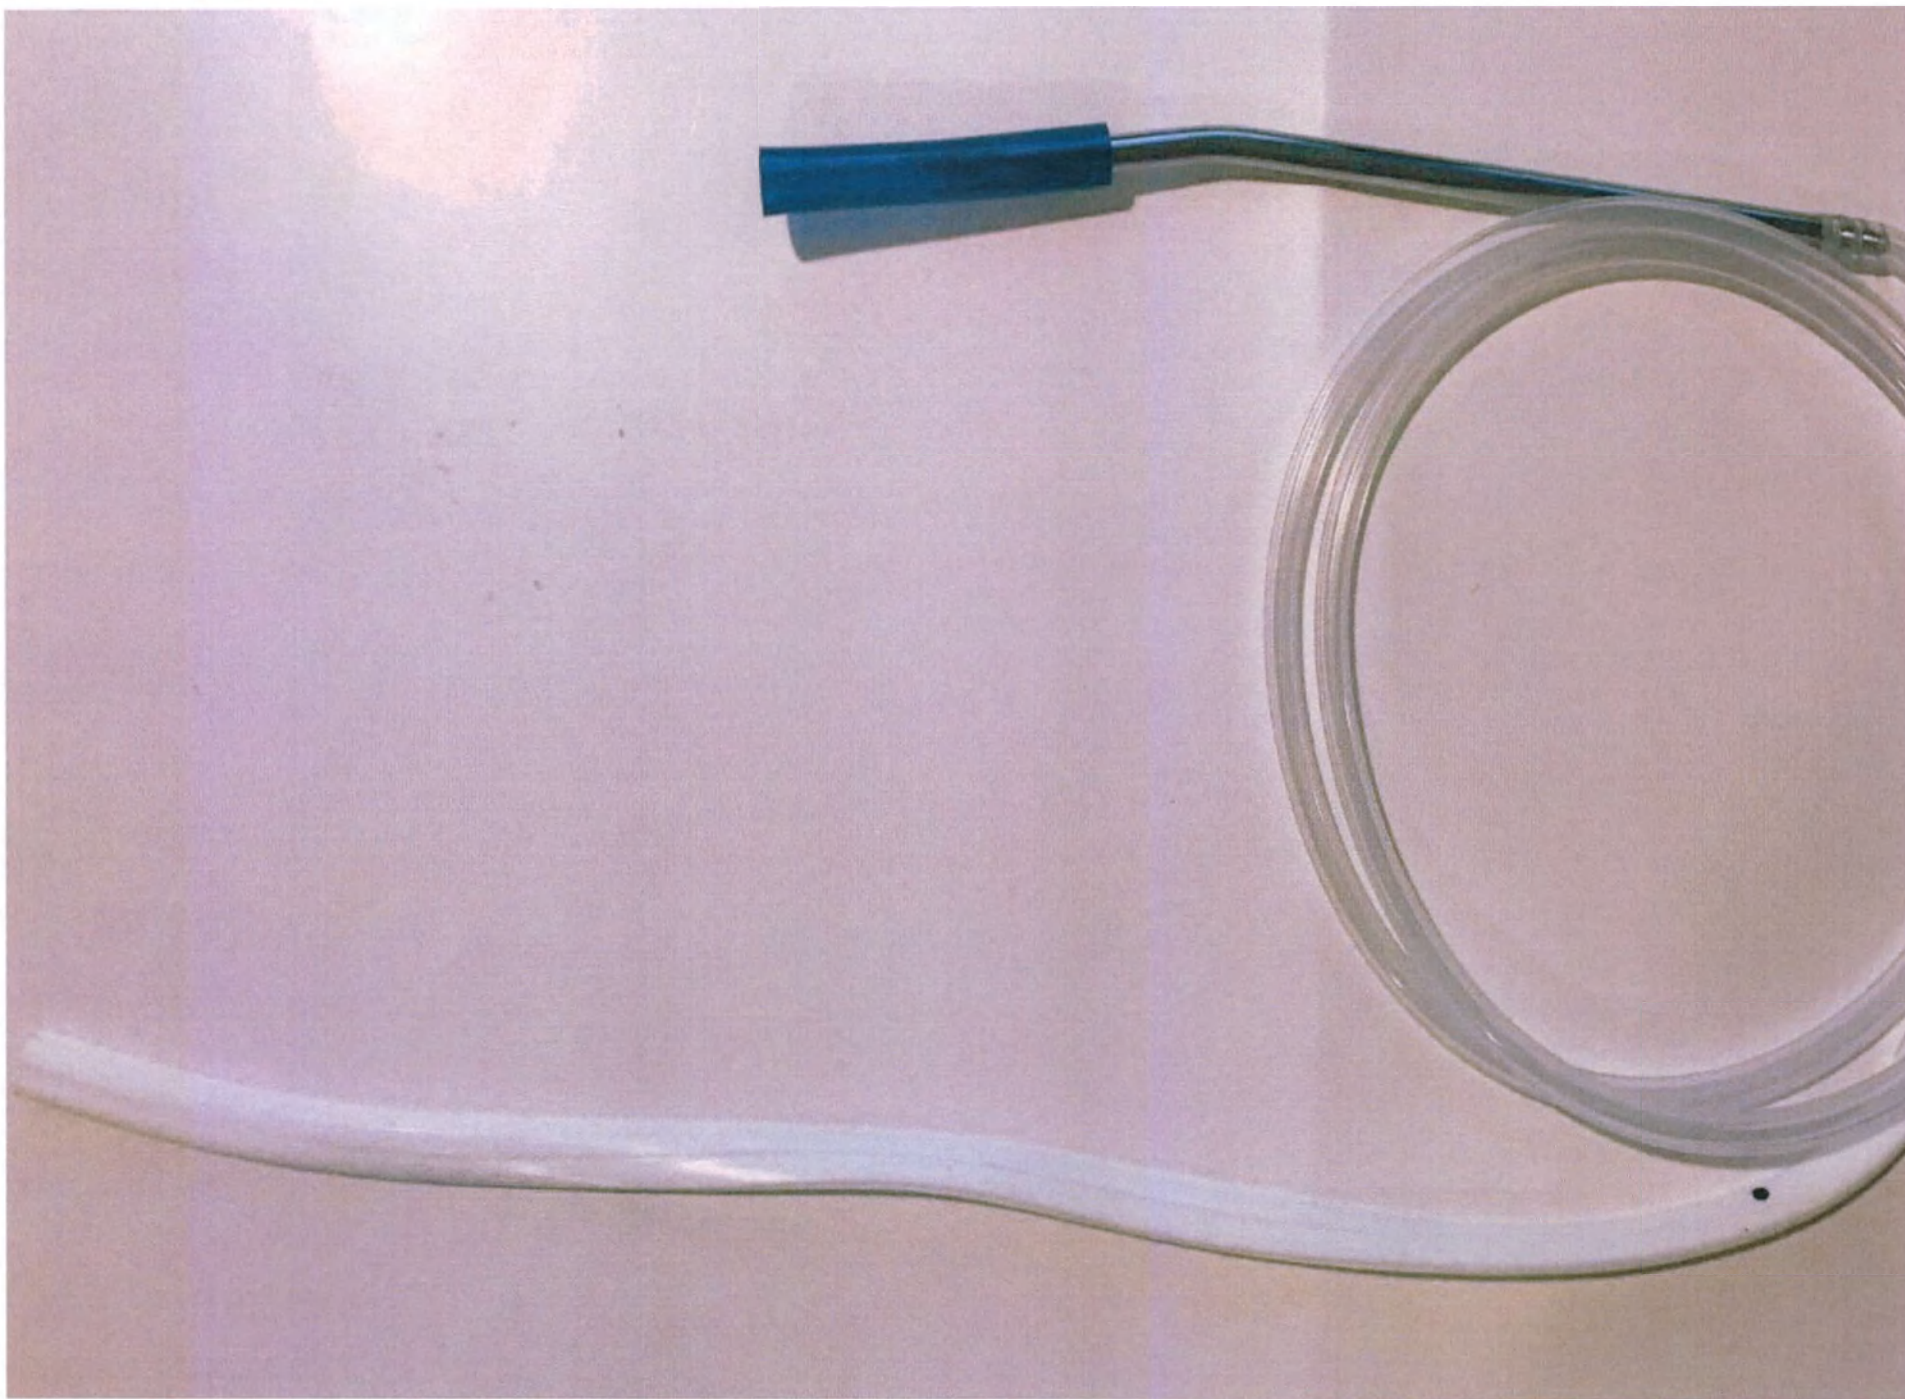


1.7. Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм, дренирующие каналы на 3/4 длины с троакар 3/16 (2216), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 7 мм, дренирующие каналы на 3/4 длины с троакар 3/16;

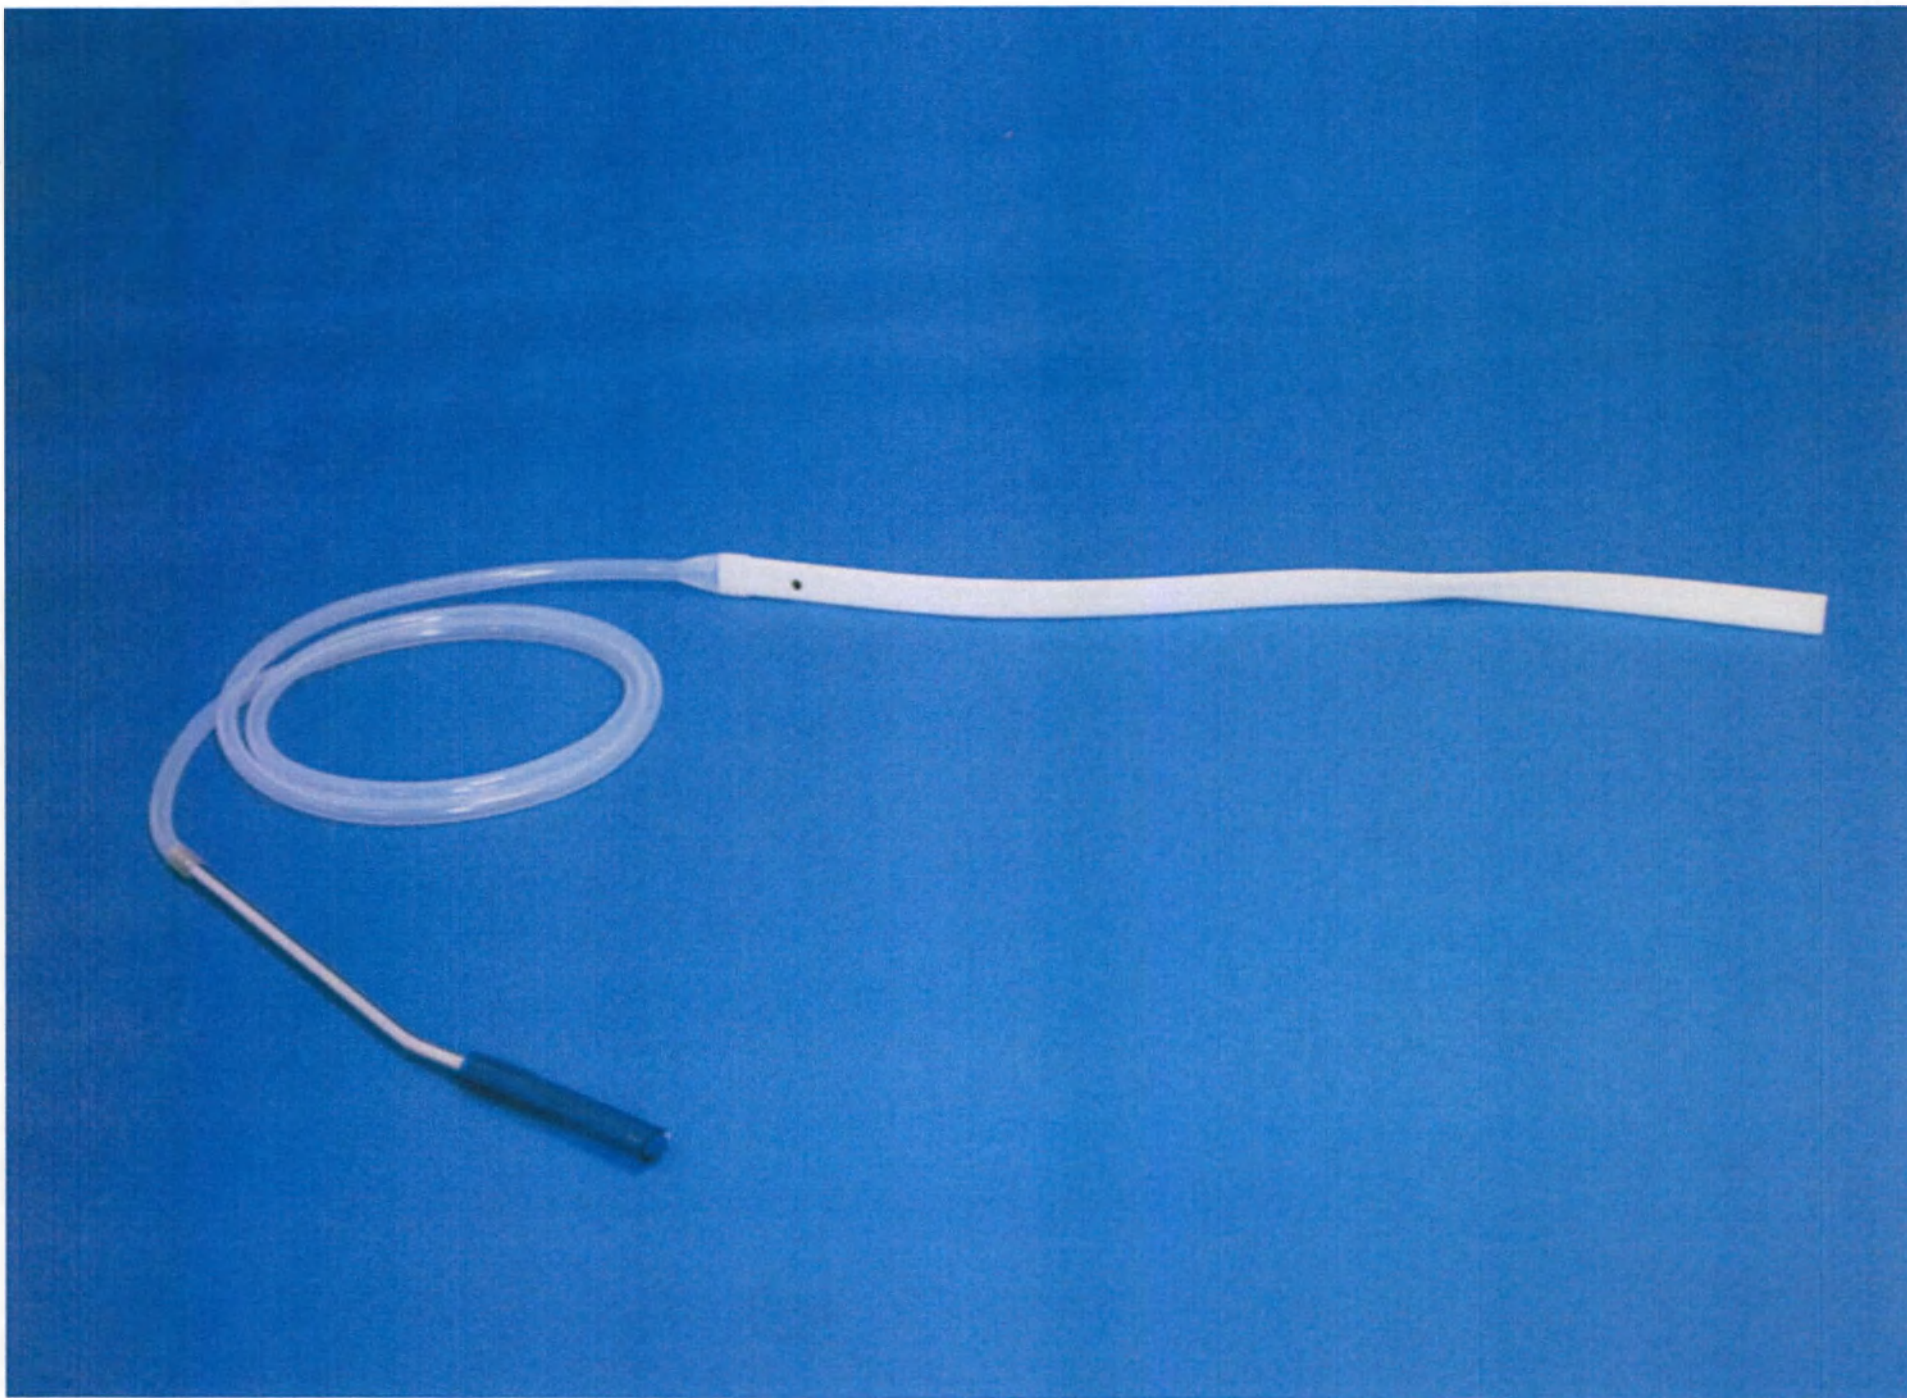


1.8. Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм, дренирующие каналы на $\frac{3}{4}$ длины с троакар 3/16 (2217), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж плоский, силиконовый Blake, 10 мм, дренирующие каналы на $\frac{3}{4}$ длины с троакар 3/16;



Переходник 1/8

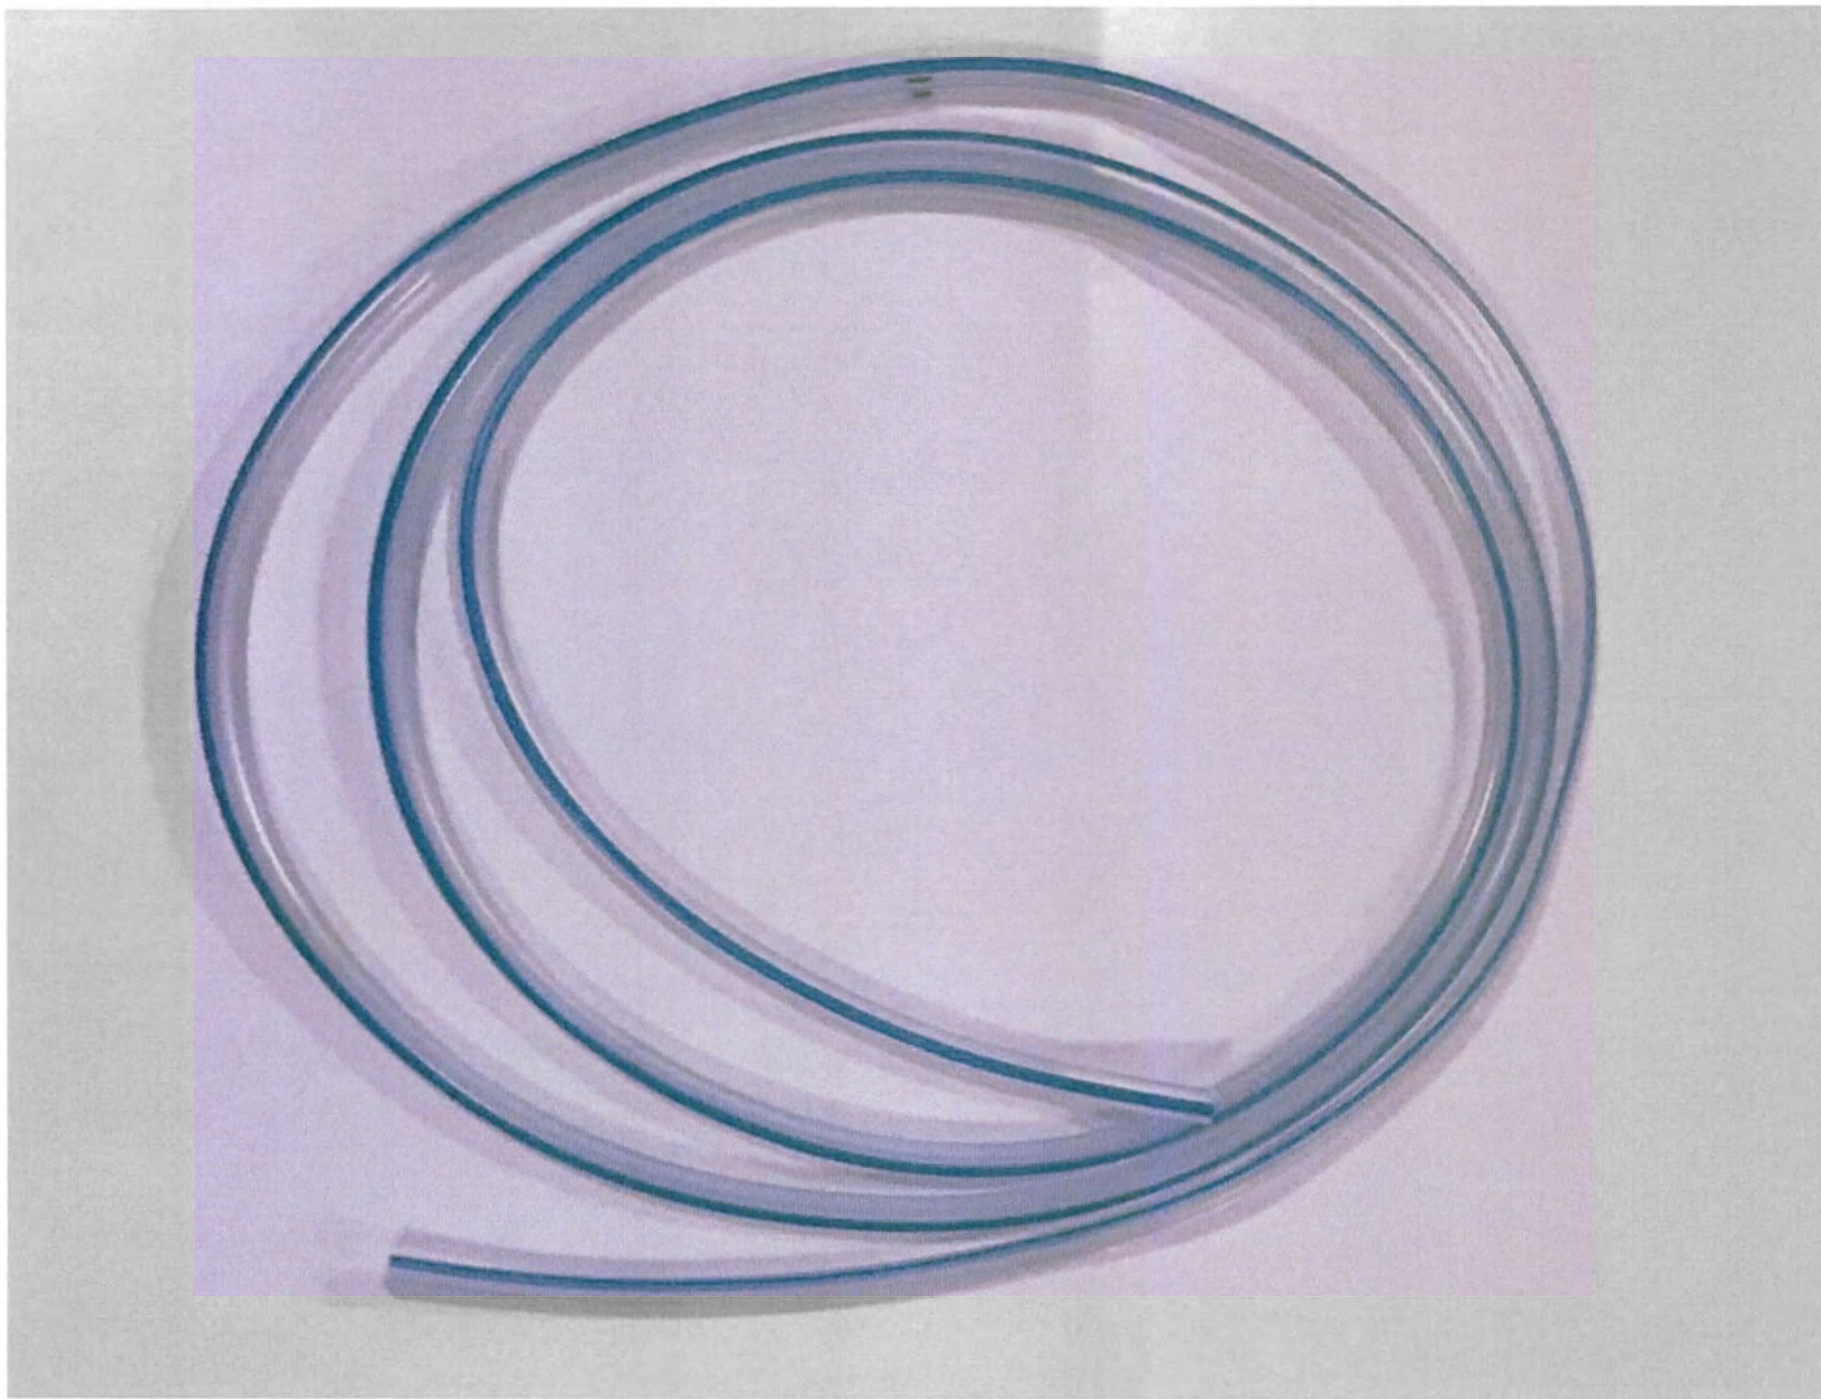


1.9. Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 10 Fr (2226), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 10 Fr;

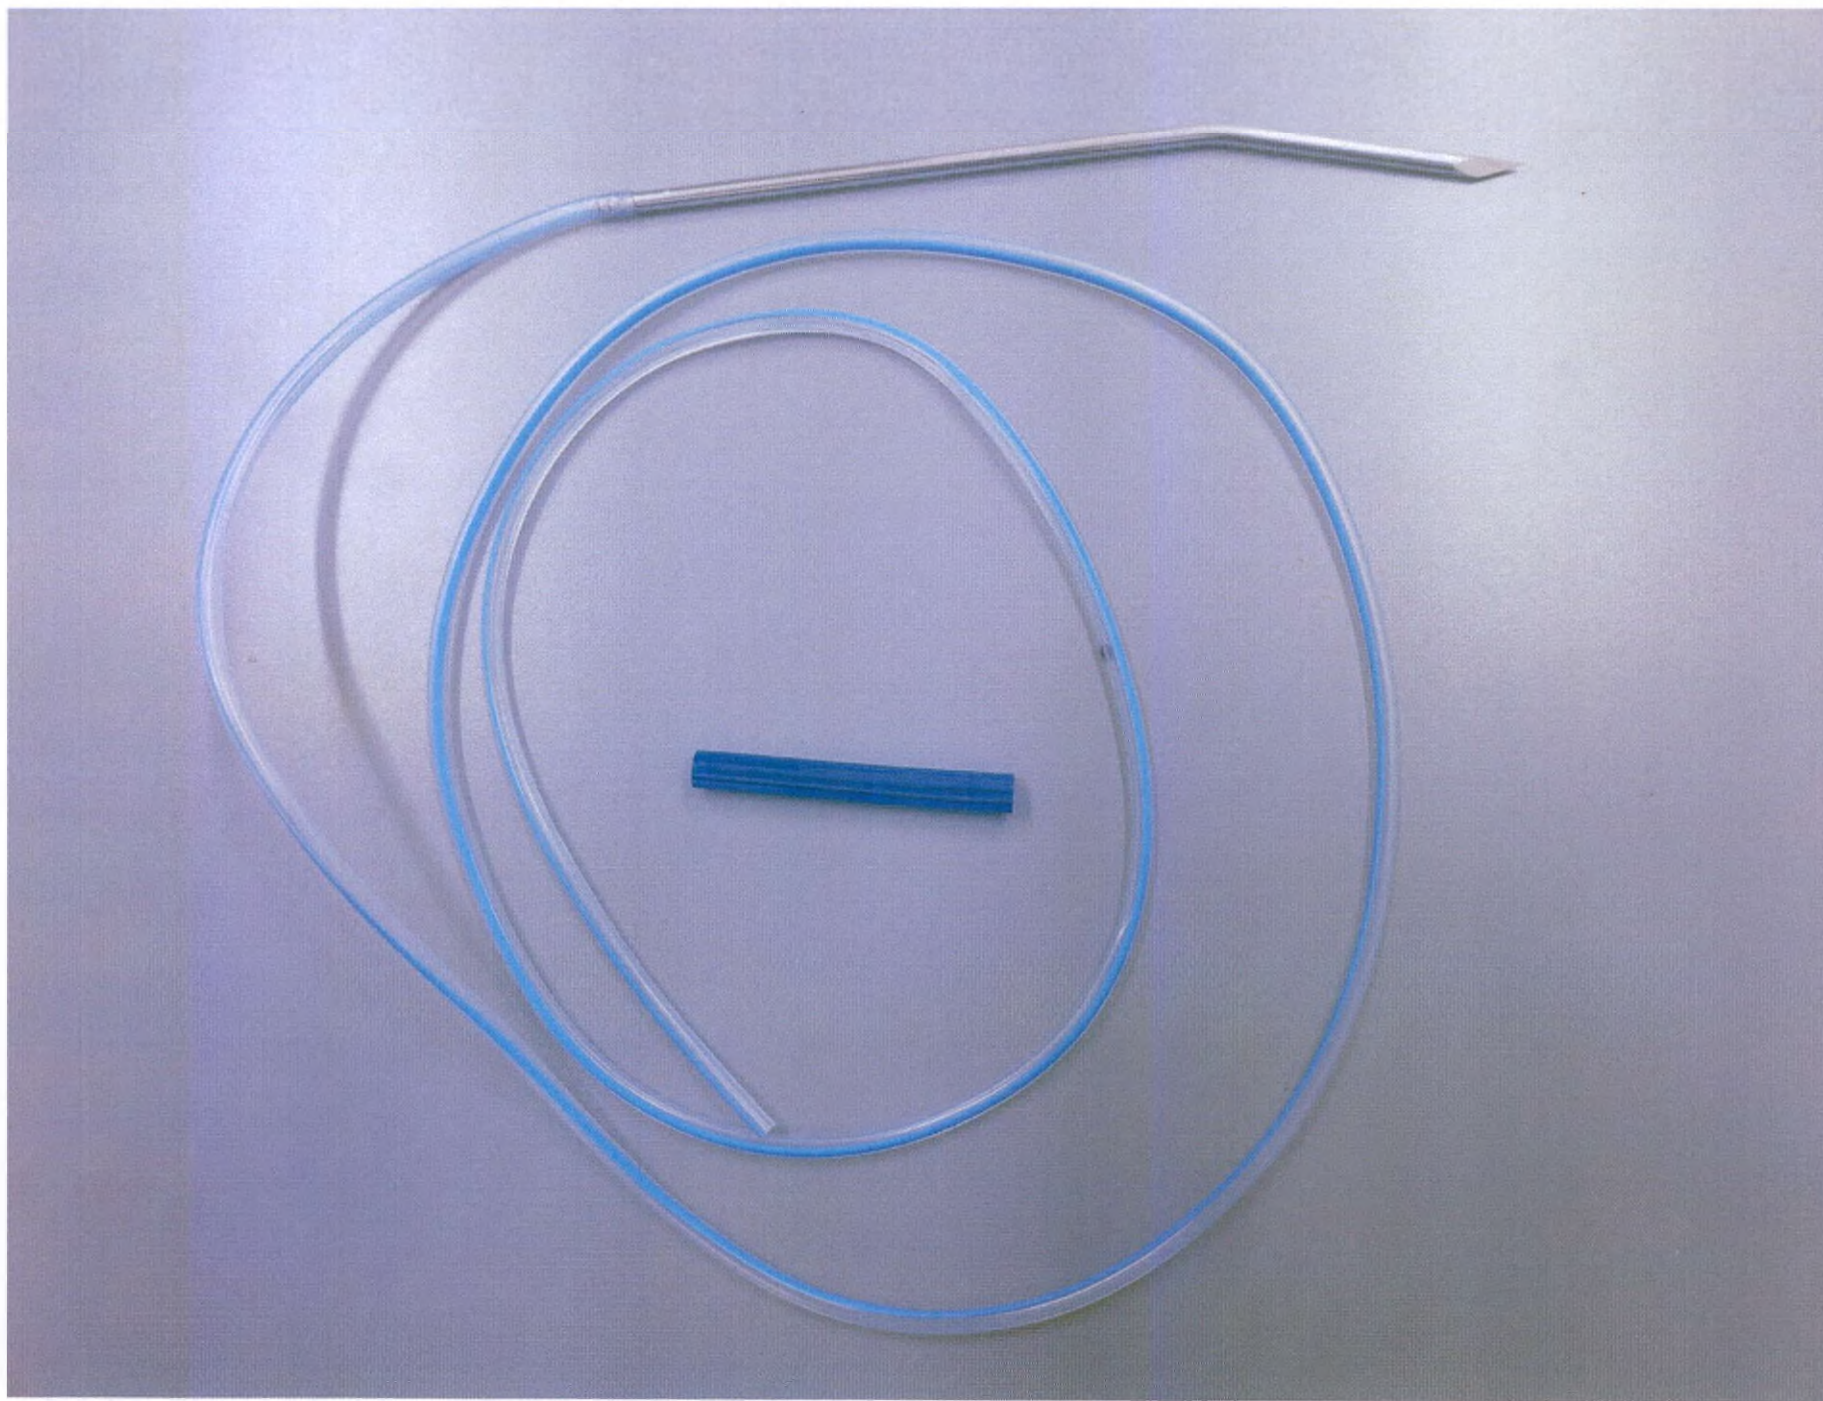


1.10. Дренаж круглый, безветулочный, силиконовый Blake, 10 Fr с троакаром 1/8 (2227), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж круглый, безветулочный, силиконовый Blake, 10 Fr с троакаром 1/8;



1.11. Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 15 Fr (2228), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 15 Fr;
- Переходник 3/16.

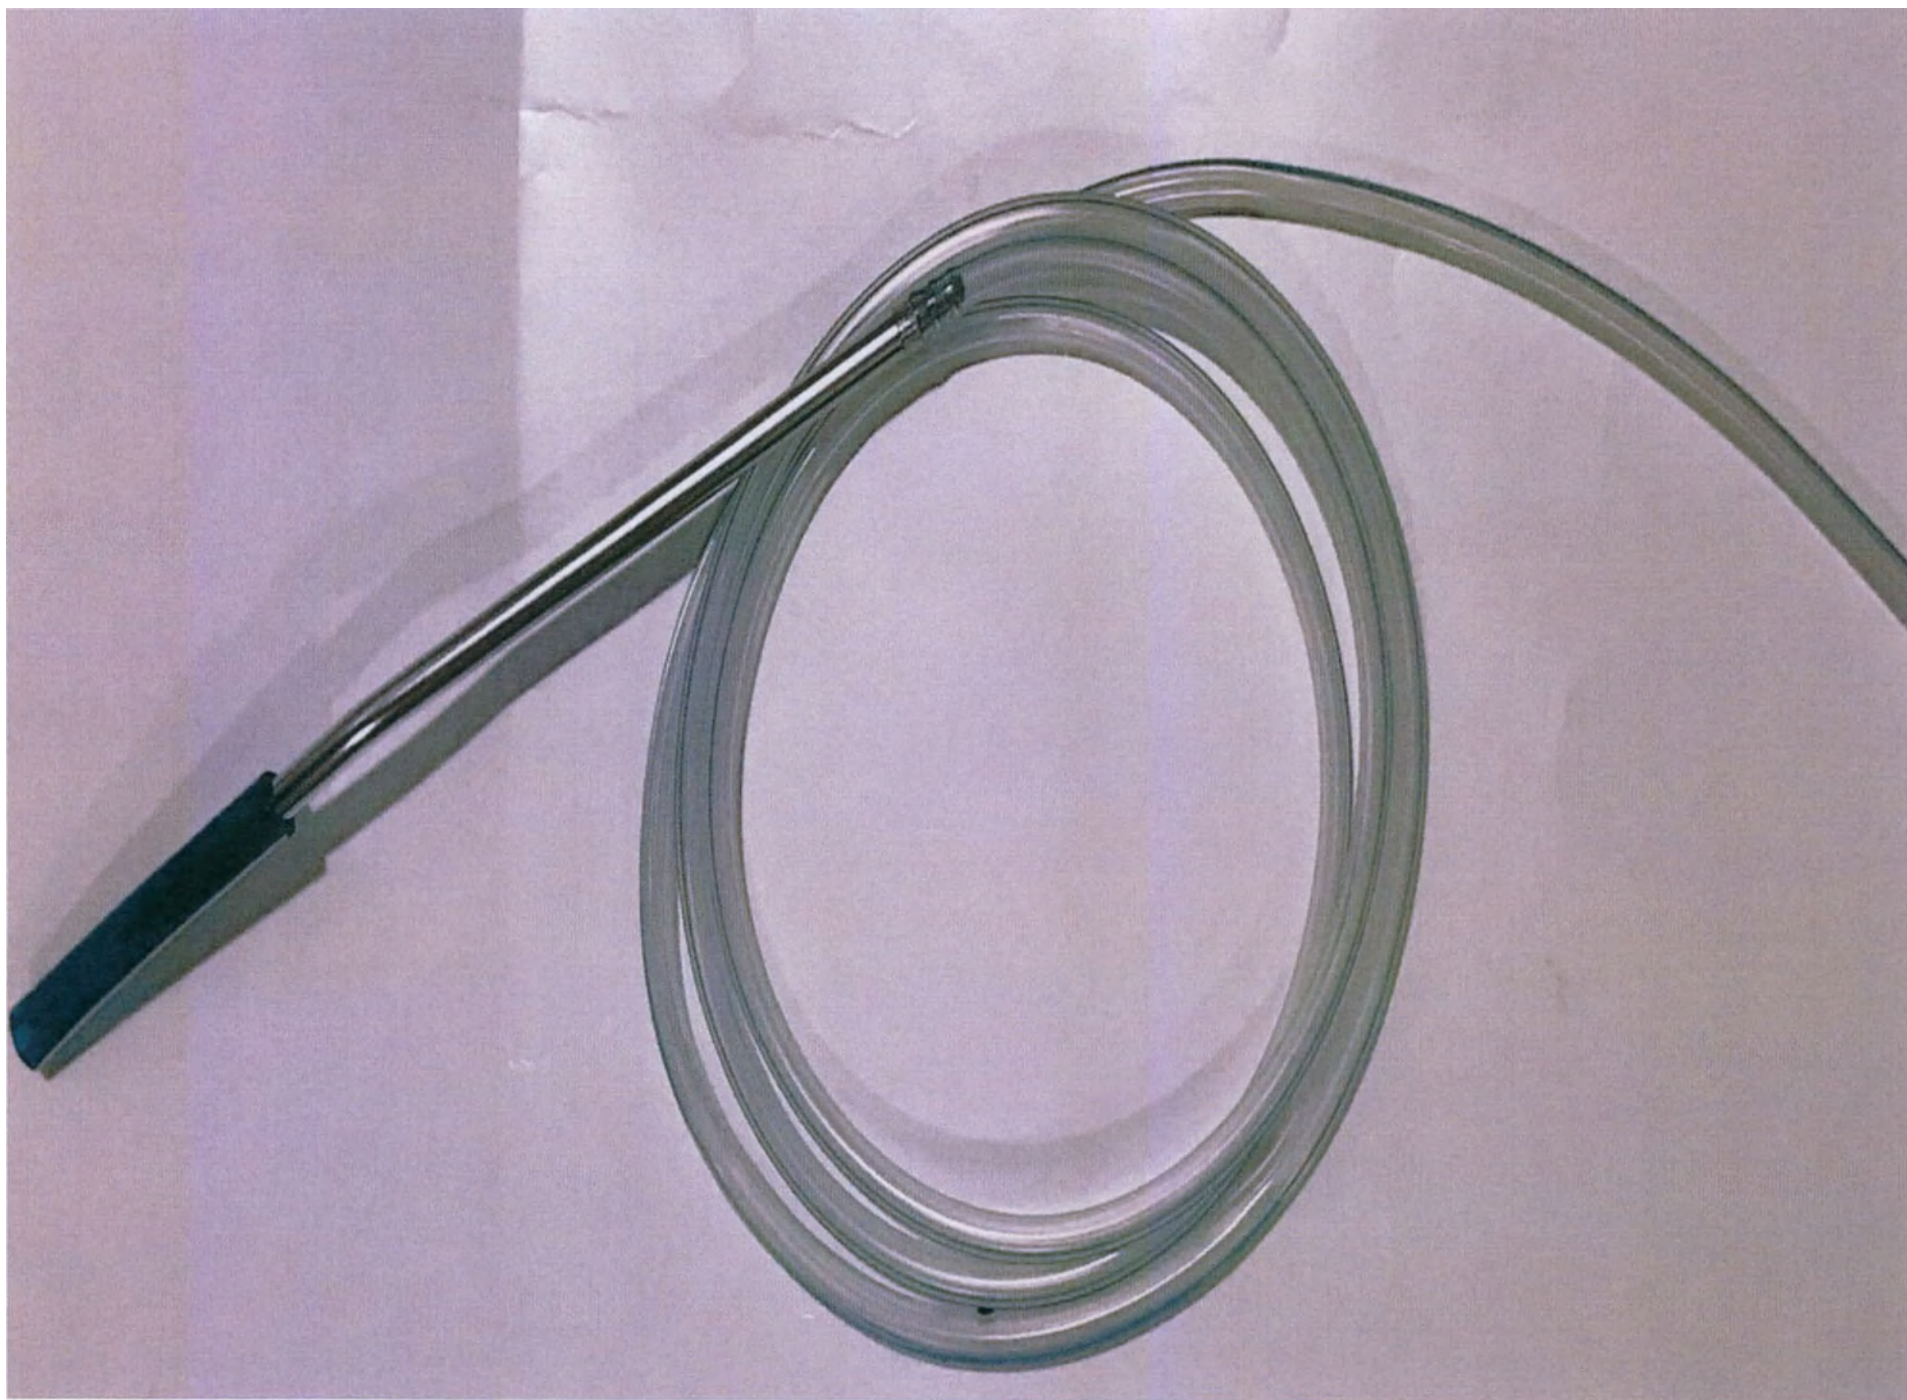


1.12. Дренаж круглый, безтулочный, силиконовый Blake, 15 Fr с троакаром 3/16 (2229), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж круглый, безтулочный, силиконовый Blake, 15 Fr с троакаром 3/16;

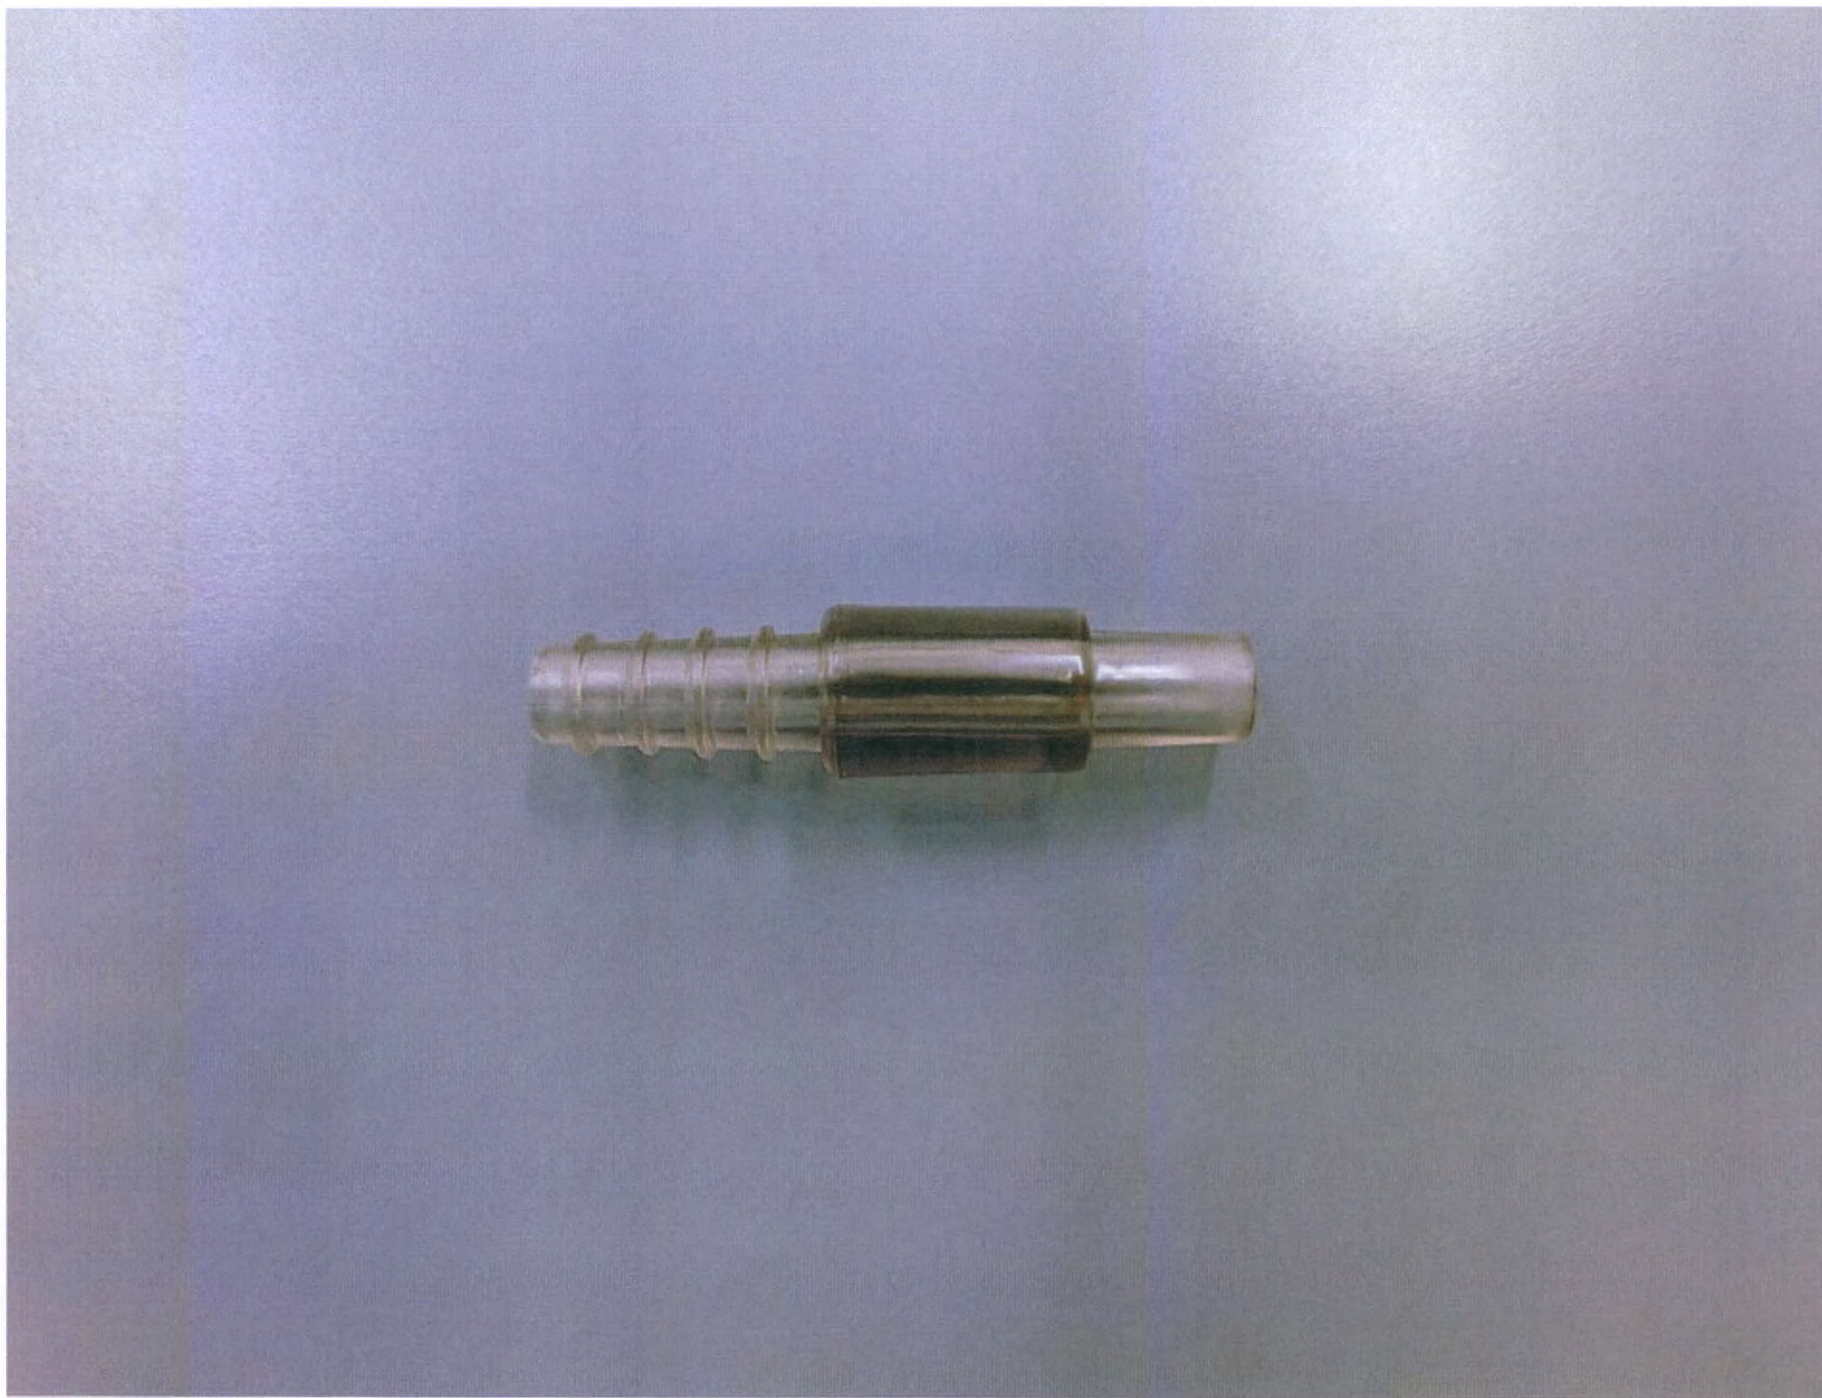


Переходник 1/4




1.13. Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 19 Fr (2230), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 19 Fr;

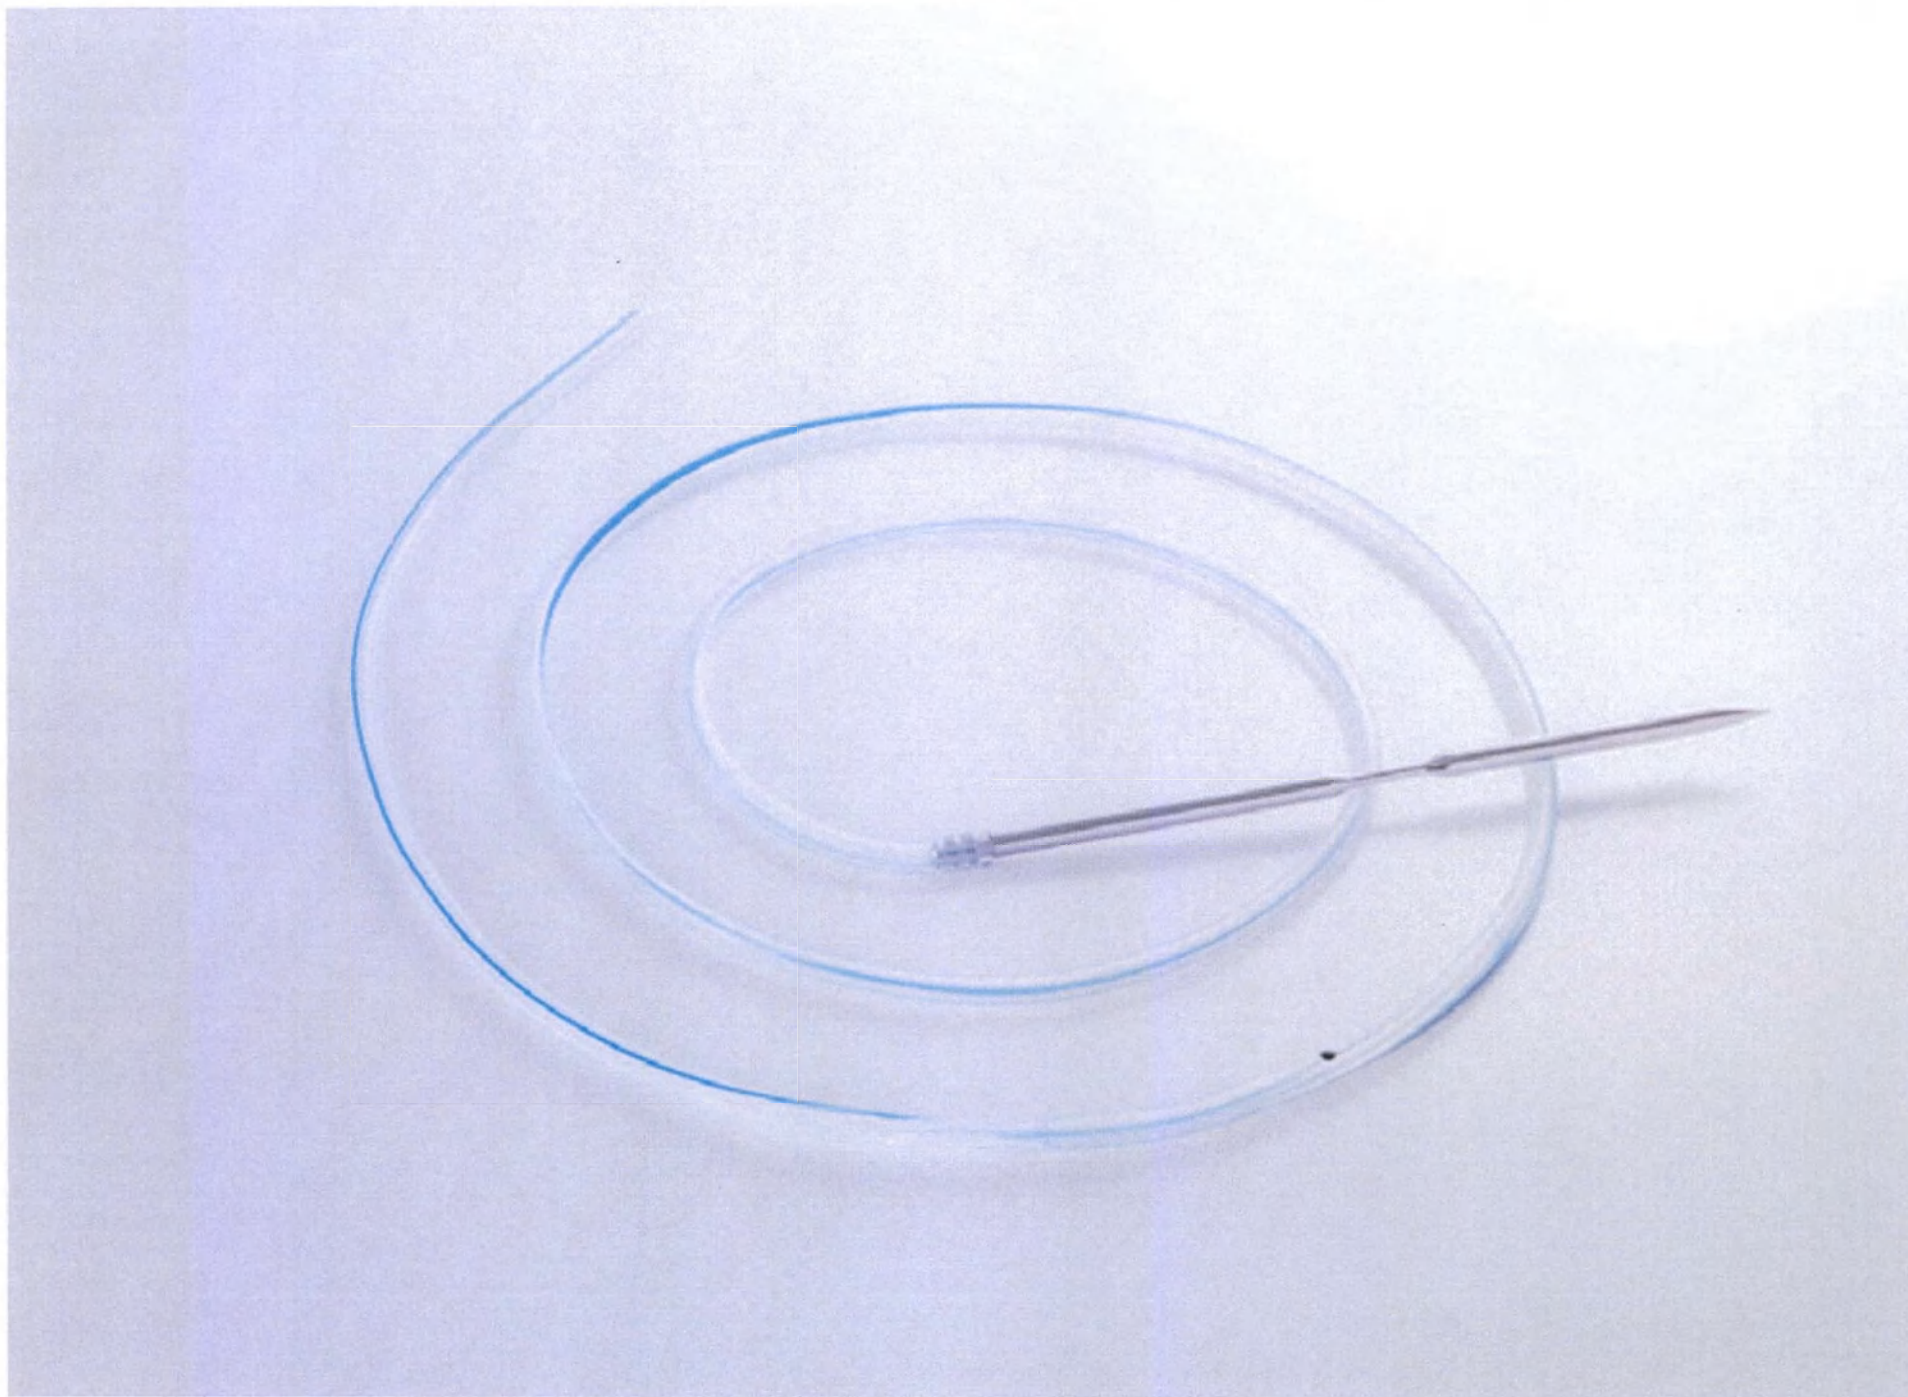


1.14. Дренаж круглый, безвулочный, силиконовый Blake, 19 Fr с троакаром 1/4 (2231), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж круглый, безвулочный, силиконовый Blake, 19 Fr с троакаром 1/4;

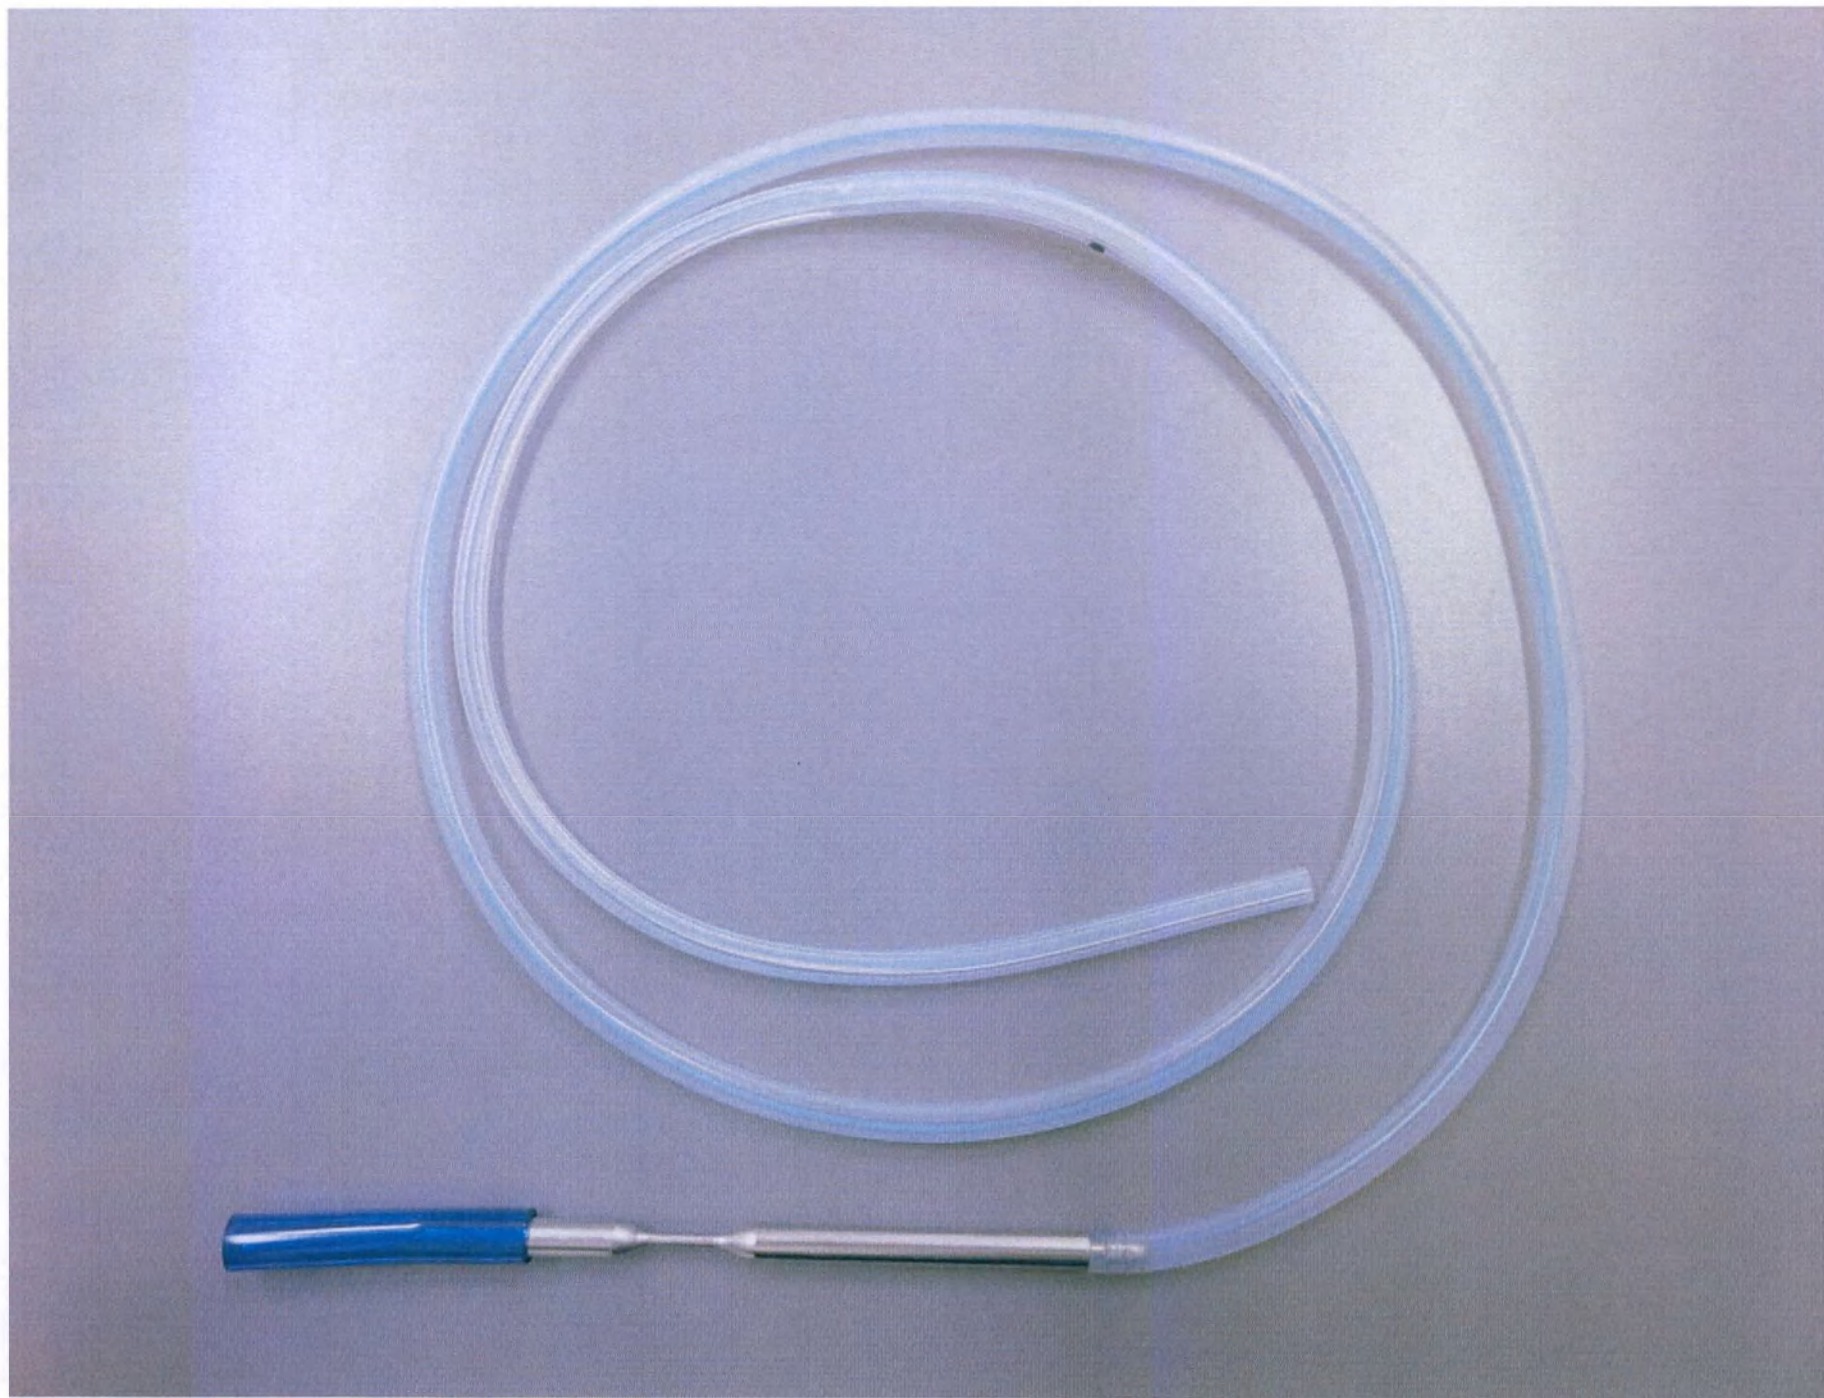

1.15. Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 19 Fr с гибким троакаром 1/4 (2232), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 19 Fr с гибким троакаром 1/4;

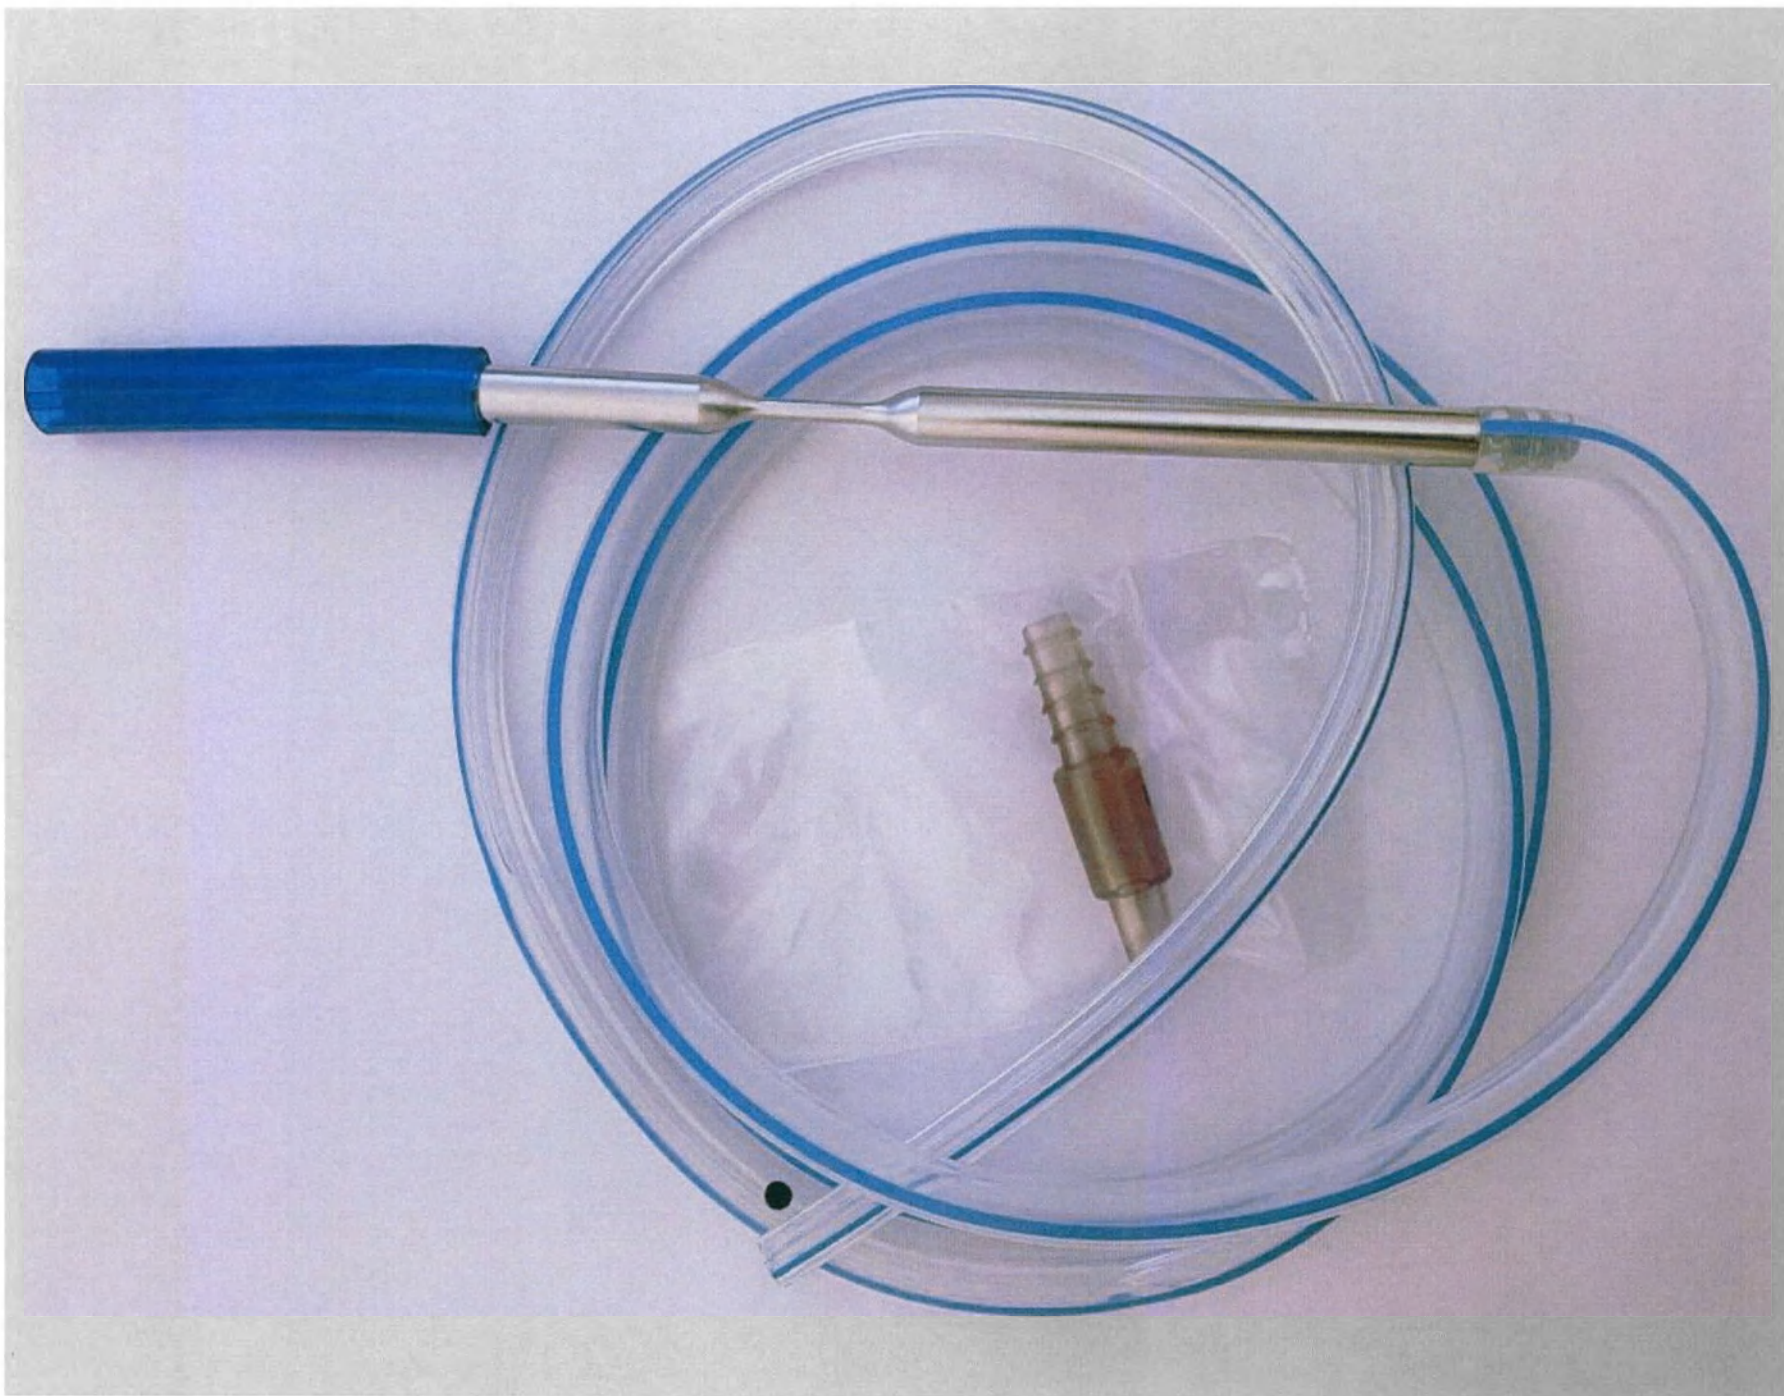

1.16. Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 15 Fr с гибким троакаром 3/16 (2233), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 15 Fr с гибким троакаром 3/16;

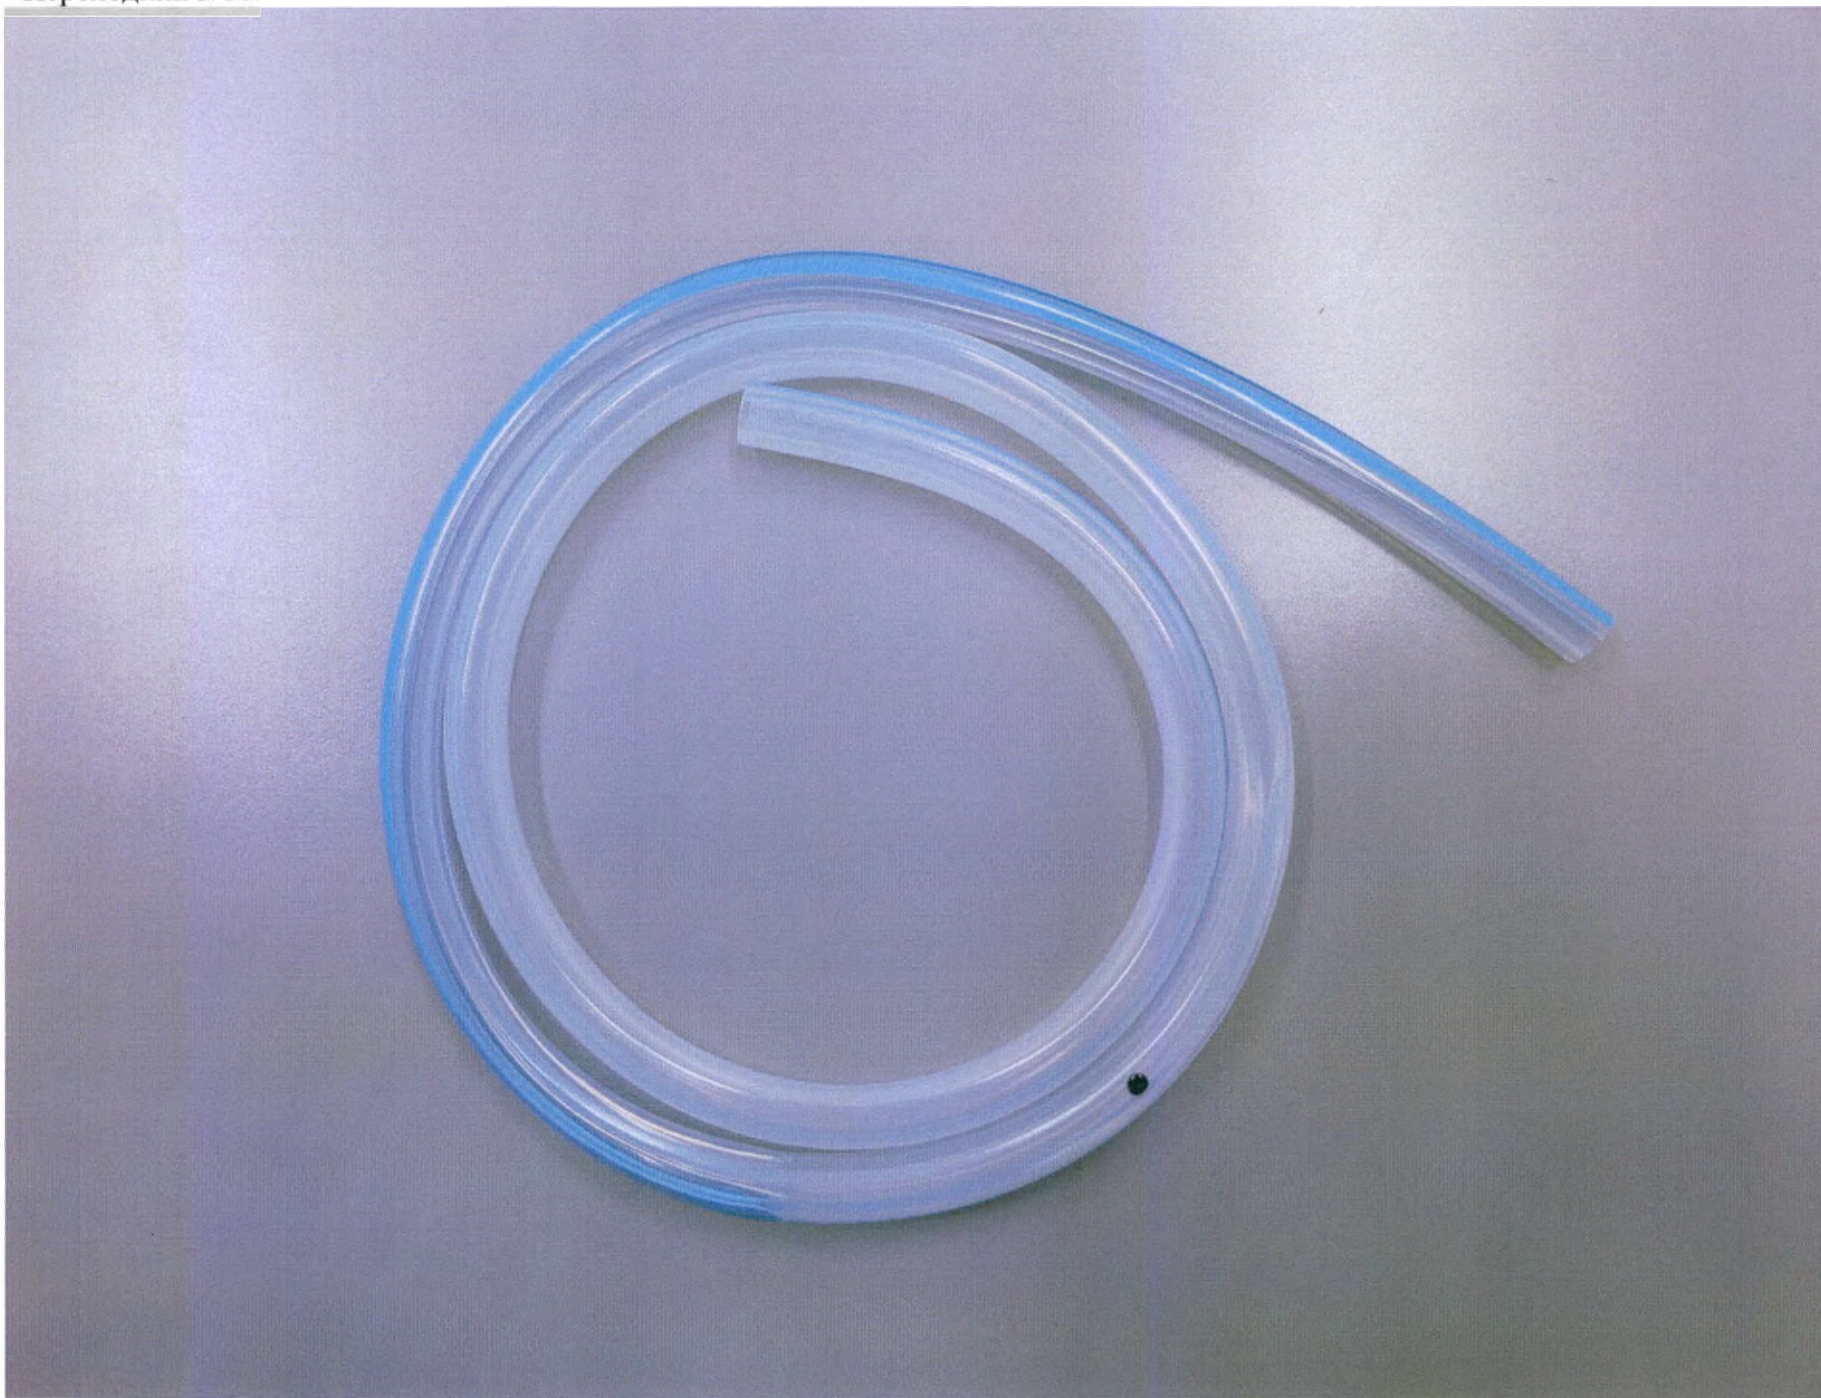

1.17. Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 24 Fr (2234), 10 шт. в уп., в составе:
- Дренаж круглый, безвтулочный, силиконовый Blake, 24 Fr;

J-VAC™

10 x



REF 2160

Bulb Suction Reservoir
100 CC WITH ANTI-REFLUX VALVE

2160.S07/LAB0011988.6

Ballon-suctiereservoir
100 ML MET ANTIREFLUXKLEP

Serbatoio di drenaggio a bulbo
100 ML CON VALVOLA ANTIRIFLUSSO

Réservoir d'aspiration en forme d'ampoule
100 ML AVEC VALVE ANTI-REFLUX

Redón de pera
100 ML CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO

Birnenförmiges Saugreservoir
100 ML MIT ANTI-RÜCKFLUSSVENTIL

Reservatório de Bomba Manual de Aspiração
100 ML COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO

Hazneli Emme Rezervuar
100 ML, ANTI-REFLÜ VALFLI



Manufactured for:

ETHICON, INC.

a Johnson & Johnson company

Route 22 West, P.O. Box 151
Somerville, New Jersey 08876-0151
USA

1-877-ETHICON
+1-513-337-6928

Made in India. HR-Drugs-667 B(H) © Ethicon, Inc. 2013

Sterilized in USA

LOT

J1920468



2024-09-10



(01)20705031003290



(17)240910(10)J1920468




(20)54

Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

2. Резервуары для дренирования J-Vac

Вторичная упаковка на примере Резервуара для дренирования J-Vac, круглого, 100 мл (2160), 10 шт. в уп.;

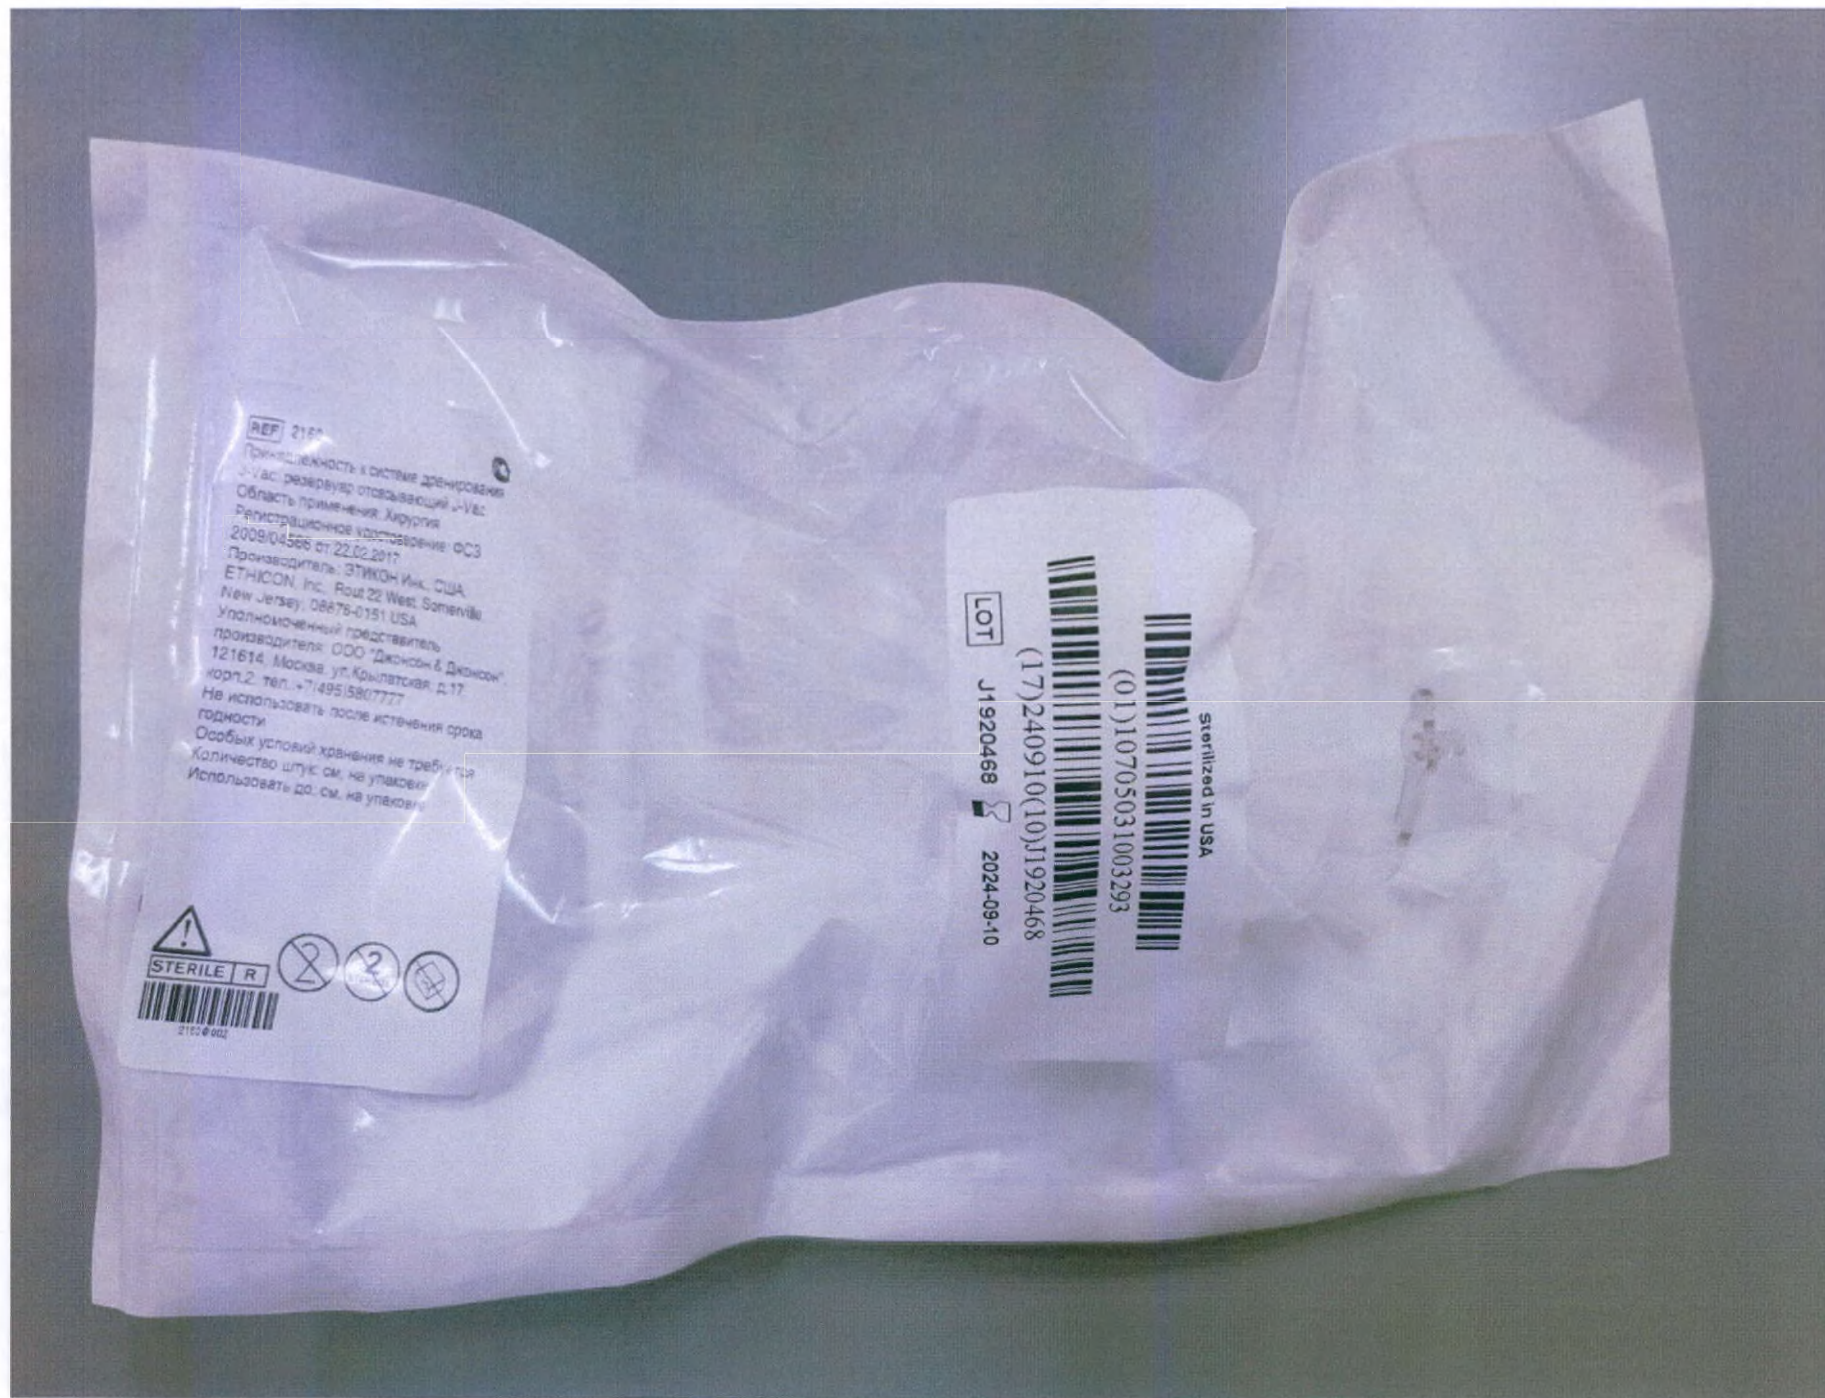

REF 2160
Принадлежность к системе дренирования
J-Vac, резервуар отсасывающий J-Vac
Область применения: Хирургия
Регистрационное удостоверение: ФСЗ
2009/04566 от 22.02.2017
Производитель: ЭТИКОН Инк. США
ETHICON, Inc. Rte 22 West, Somerville
New Jersey, 08876-0151 USA
Уполномоченный представитель
производителя: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская, д.17
корп.2, тел. +7(495)5807777
Не использовать после истечения срока
годности
Особых условий хранения не требуется
Количество штук см. на упаковке
Использовать до см. на упаковке



LOT J1920468 2024-09-10




Sterilized in USA


Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

2. Резервуары для дренирования J-Vac


Первичная упаковка на примере Резервуара для дренирования J-Vac, круглого, 100 мл (2160), 10 шт. в уп.;

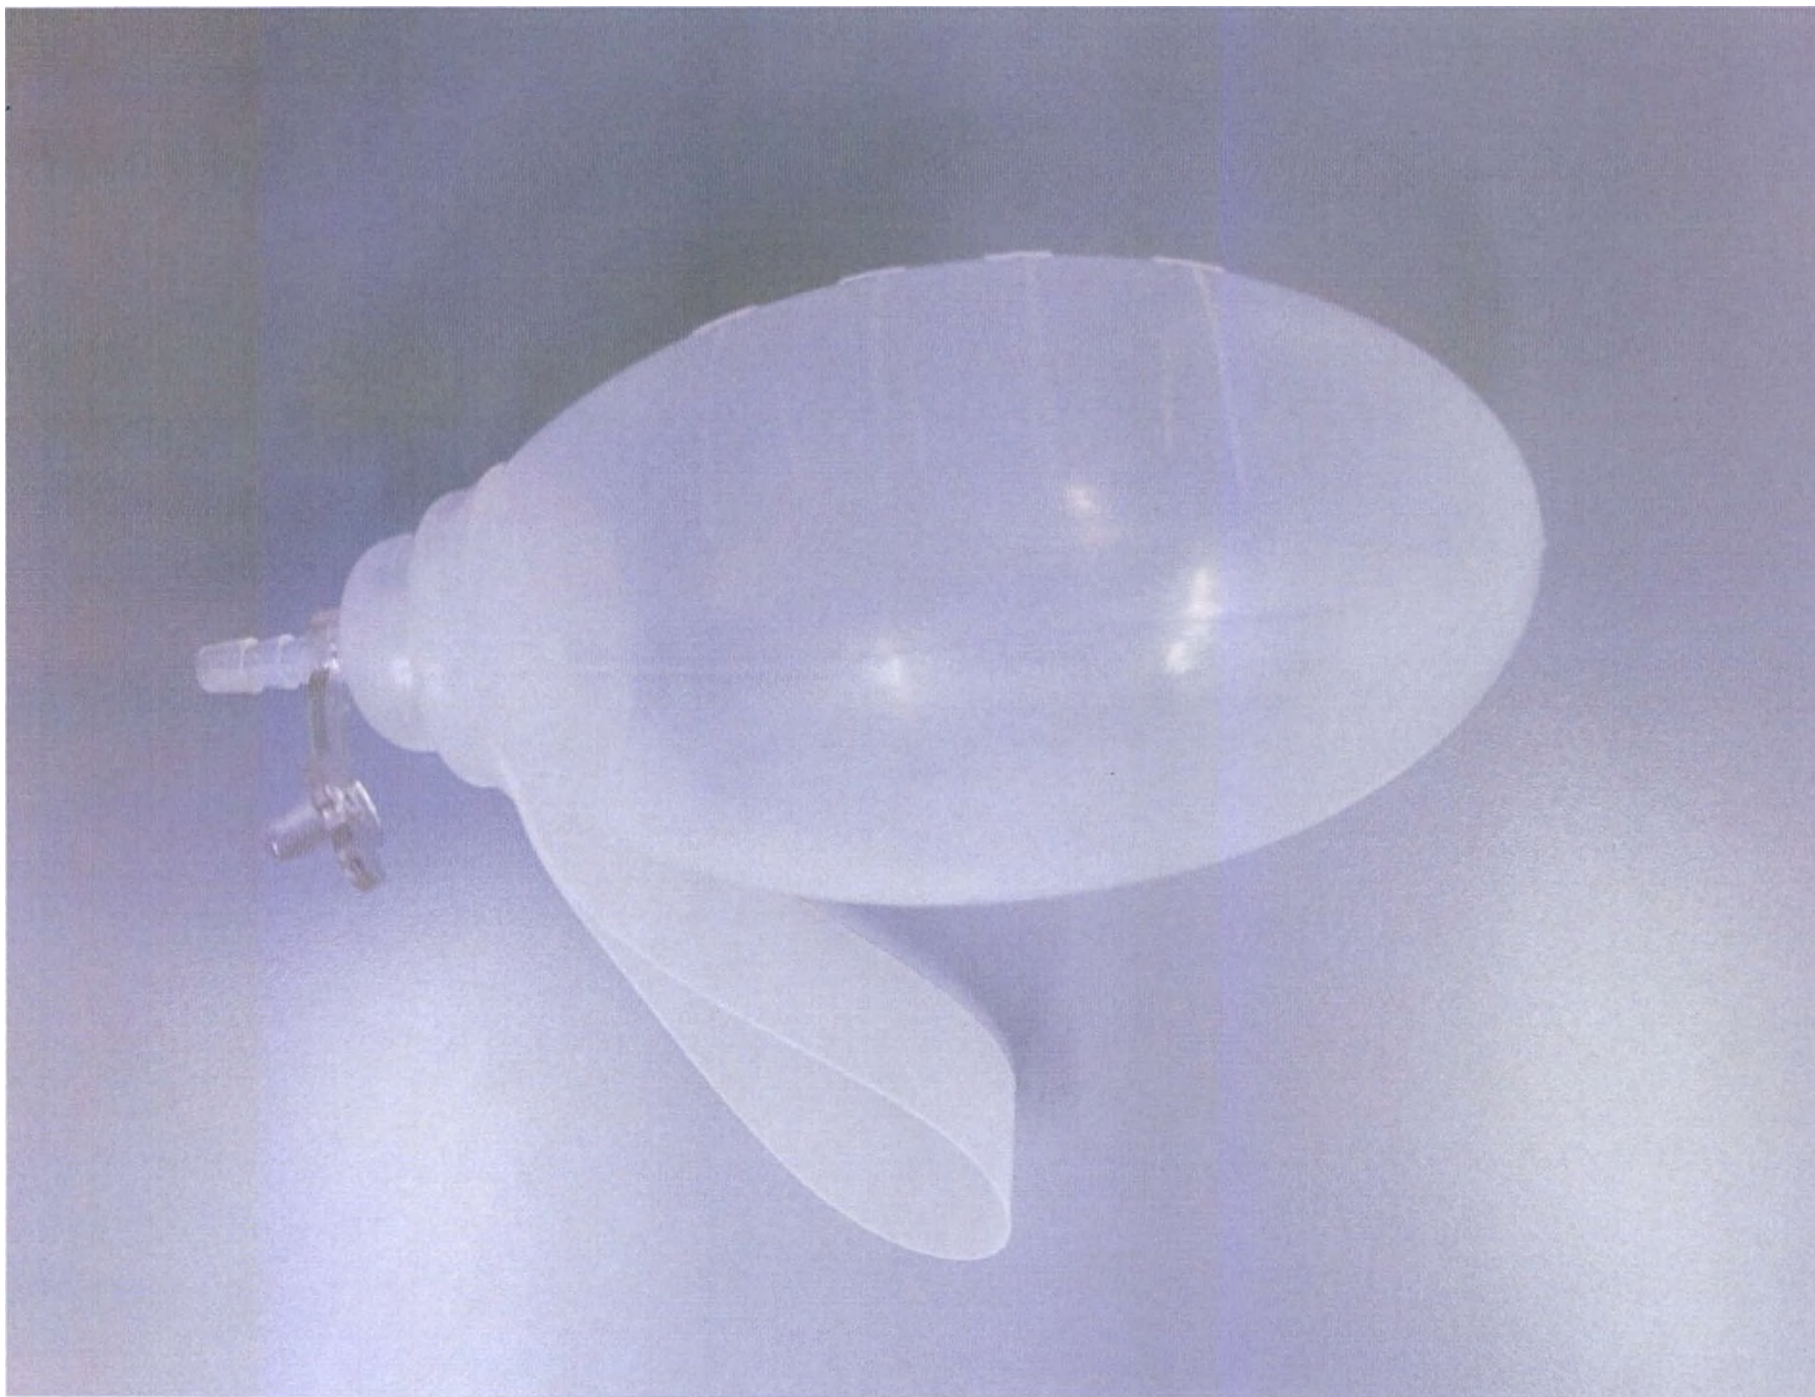


2.1. Резервуар для дренирования J-Vac, круглый, 100 мл (2160)

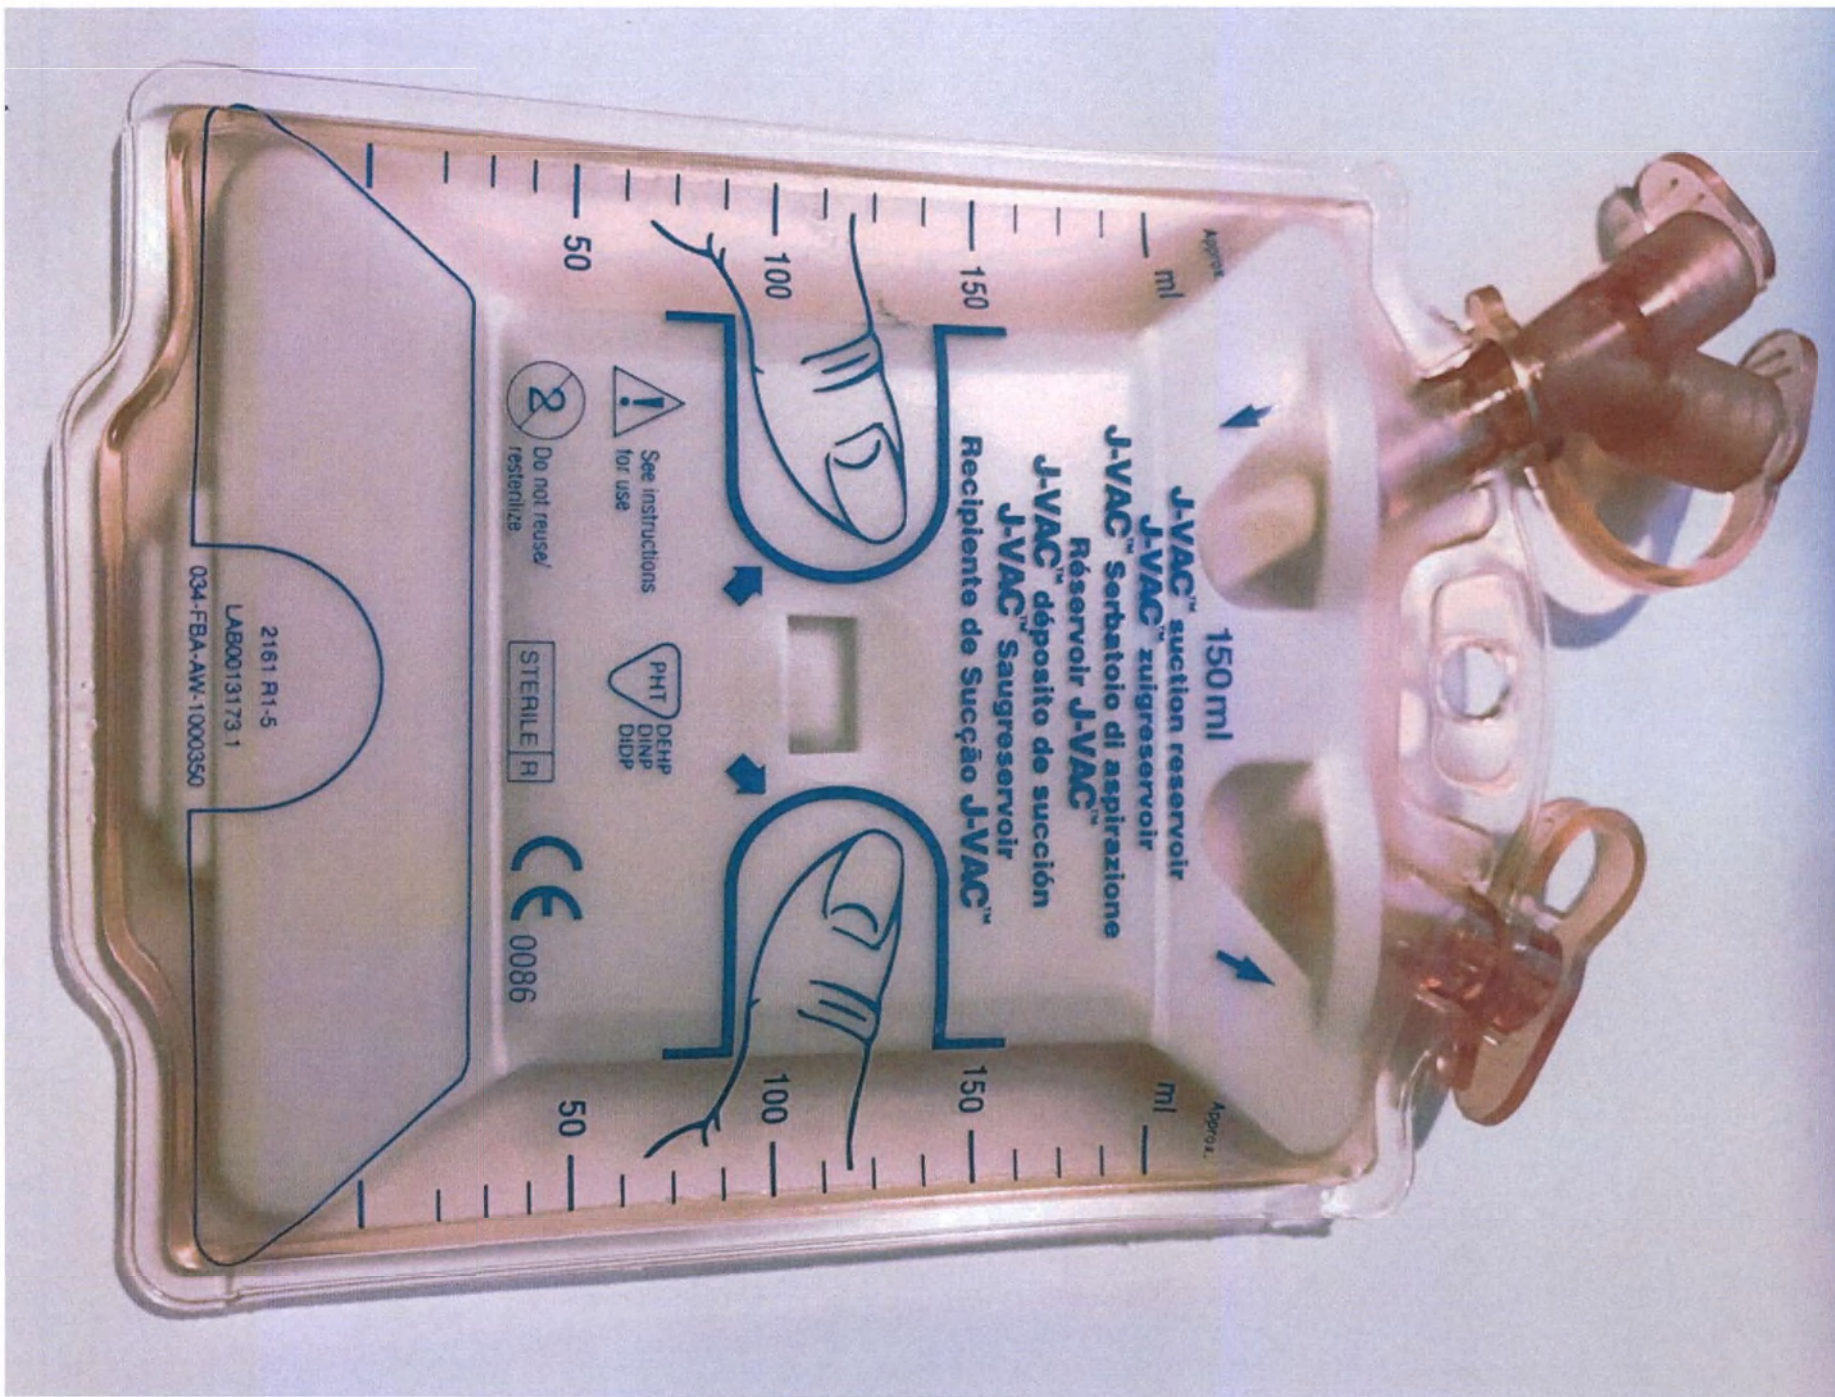

2.2. Резервуар для дренирования J-Vac, плоский, 150 мл (2161)

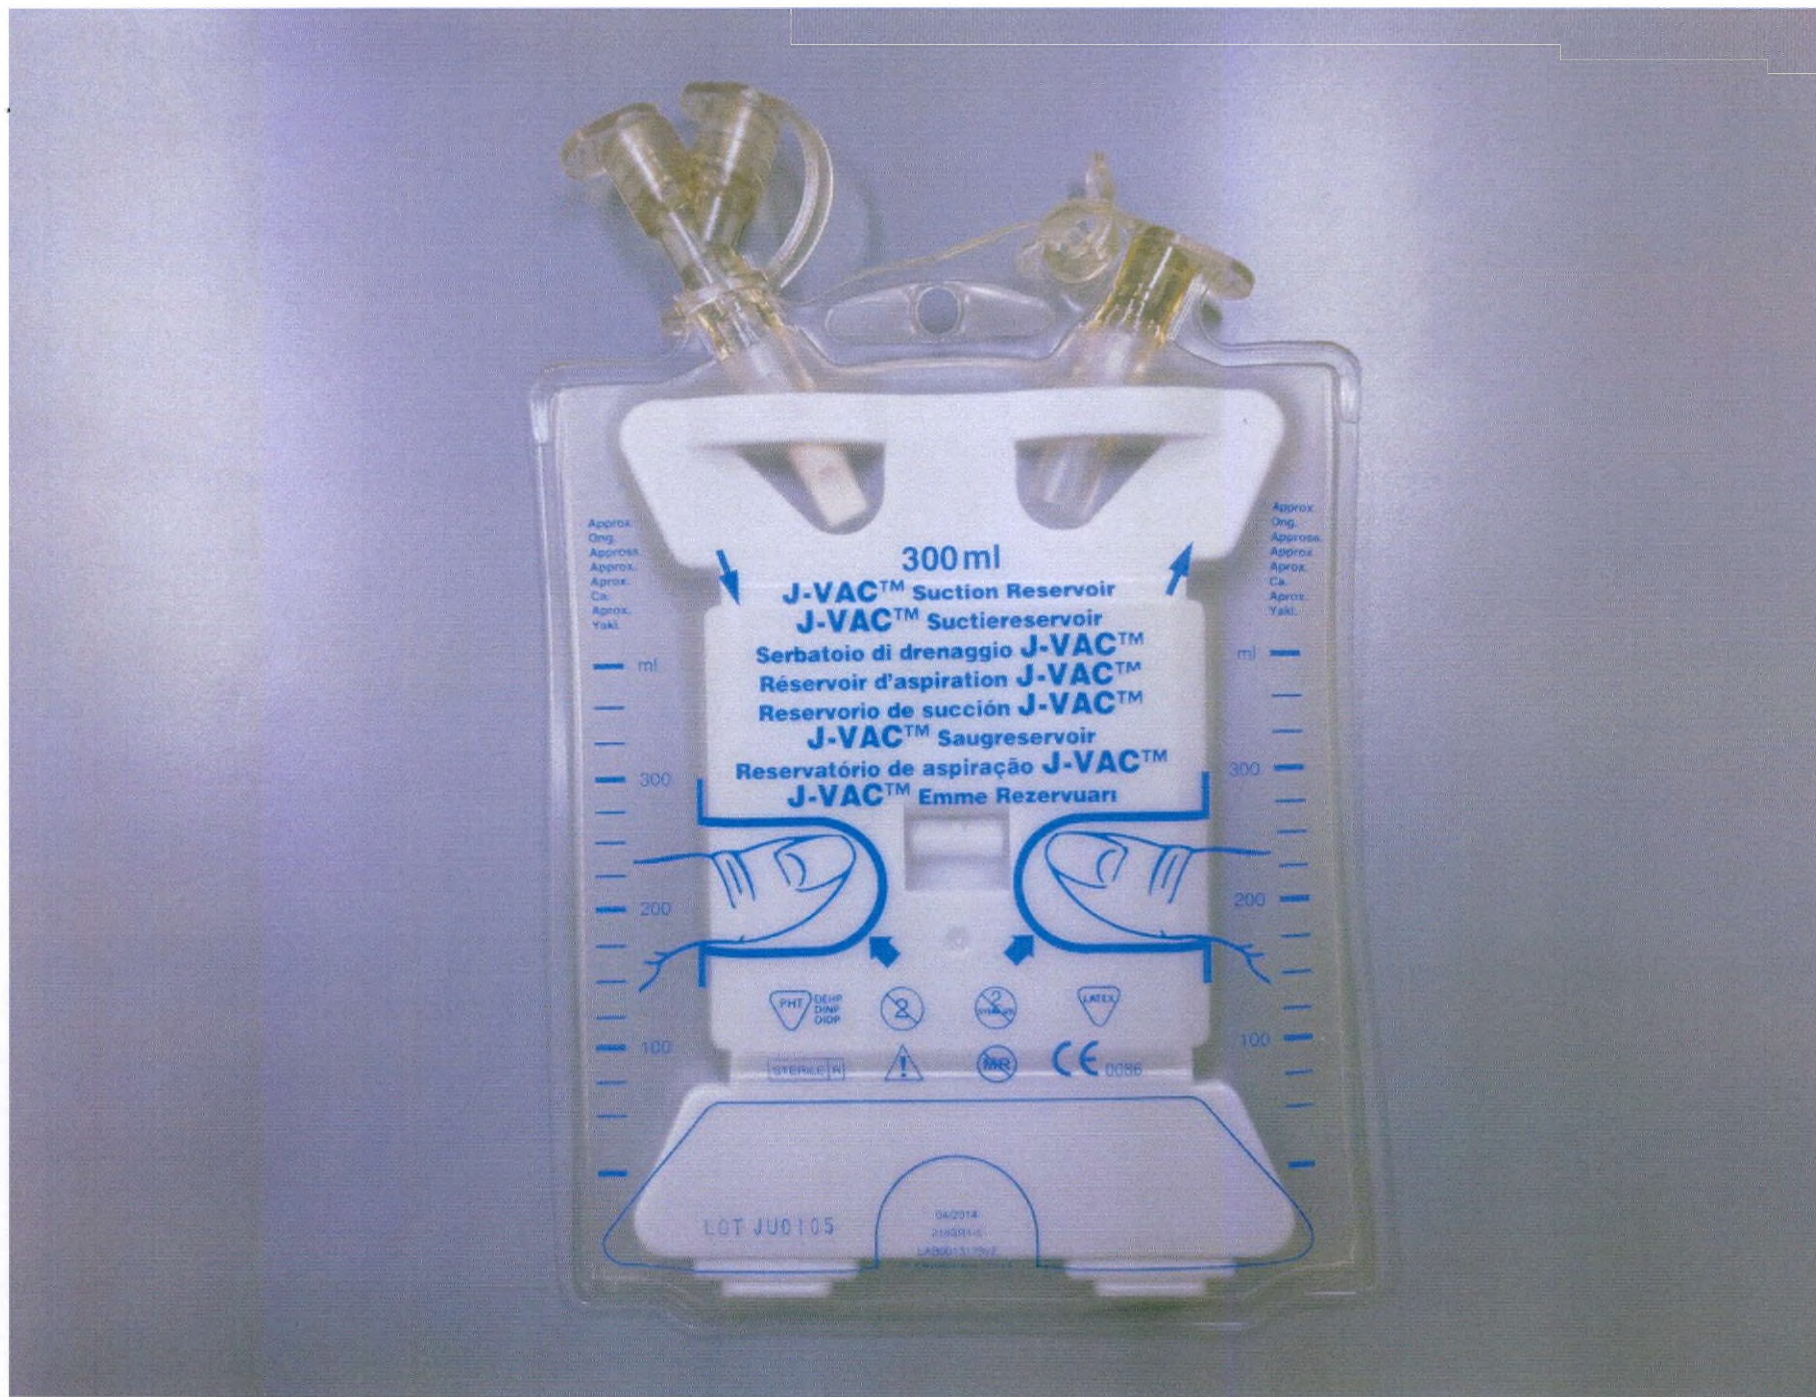

2.3. Резервуар для дренирования J-Vac, плоский, 300 мл (2163)

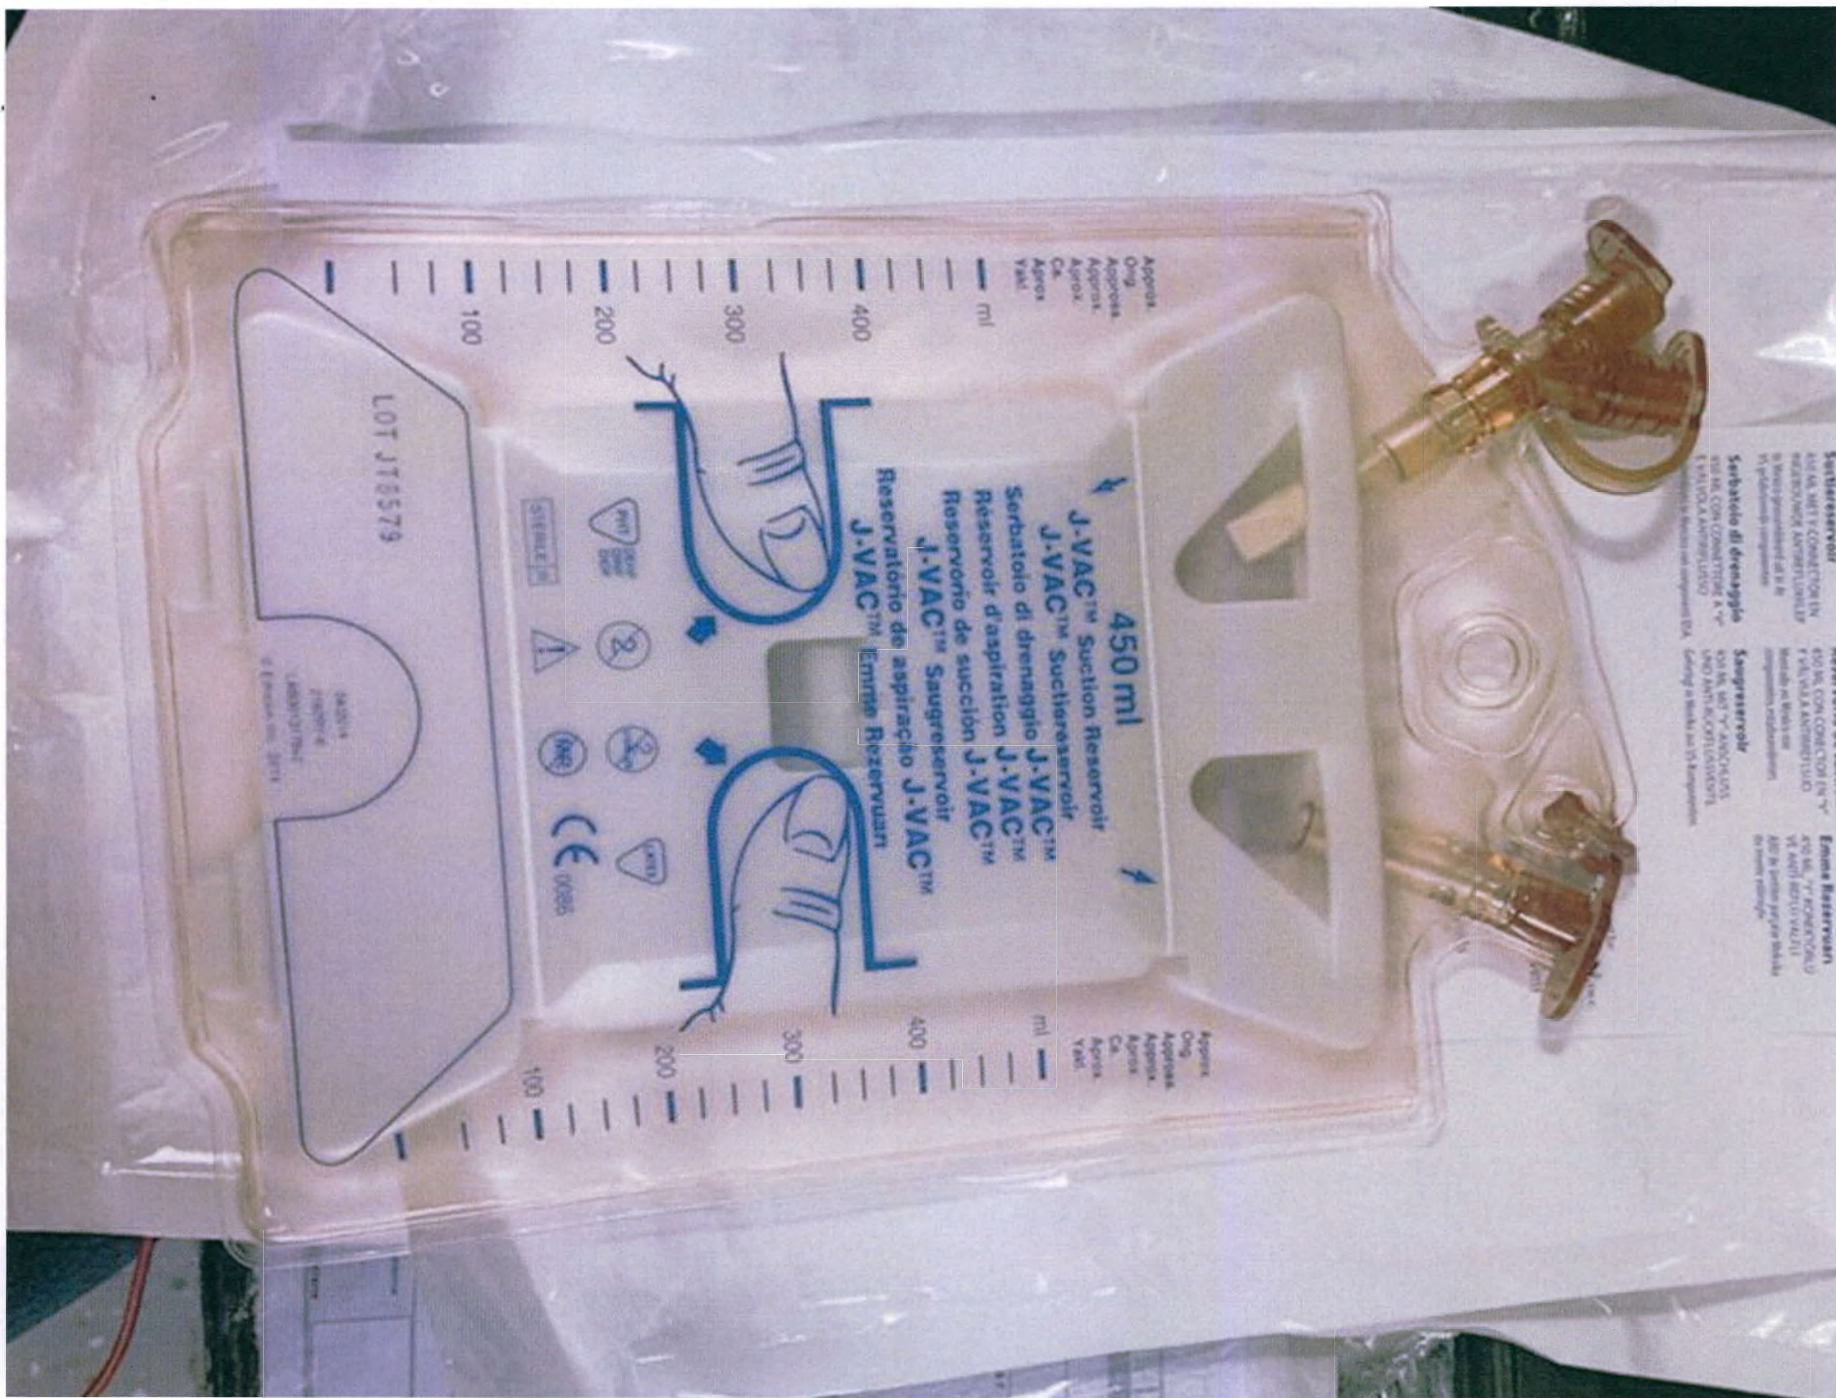

2.4. Резервуар для дренирования J-Vac, плоский, 450 мл (2162)

blake
Suture Drains

Cardio Connector 1:1

BCC1.S04/LAB0011996.3

Cardio Connector 1:1

Connettore cardiaco 1:1

Sterilized in USA

BC REP

Johnson & Johnson Medical Ltd
Simpson Parkway
Kilwinning Campus
Livingston
EH54 7AT
United Kingdom


LOT

J1902599



2024-02-07

20 x



3/8" - 1/2" x 3/16"
(10-13 mm x 5 mm)

BCC1

Connecteur cardio 1:1

Conector cardíaco 1:1

Kardio-Konnektor 1:1

Cardioconector 1:1

Kardiyo Konektörü 1:1



Manufactured for:

ETHICON, INC.

a Johnson & Johnson company

Route 22 West, P.O. Box 151
Somerville, New Jersey 08876-0151
USA

1-877-ETHICON
+1-513-337-6928

© Ethicon, Inc. 2013 HR-Drugs-667 (H)
Made in U.S.A.

CE 0086



STERILE R



(01)20705031023311



(17)240207(10)J1902599



(20)42

Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

3. Кардиоконнекторы Blake

Вторичная упаковка на примере Кардиоконнектора Blake 1:1 (BCC1), 20 шт. в уп.;



Система для закрытого дренирования ран Blake и J-Vac

3. Кардиоконнекторы Blake


Первичная упаковка на примере Кардиоконнектора Blake 1:1 (BCC1)



3.1. Кардиоконнектор Blake 1:1 (BCC1)



3.2. Кардиоконнектор Blake 2:1 (BCC2)

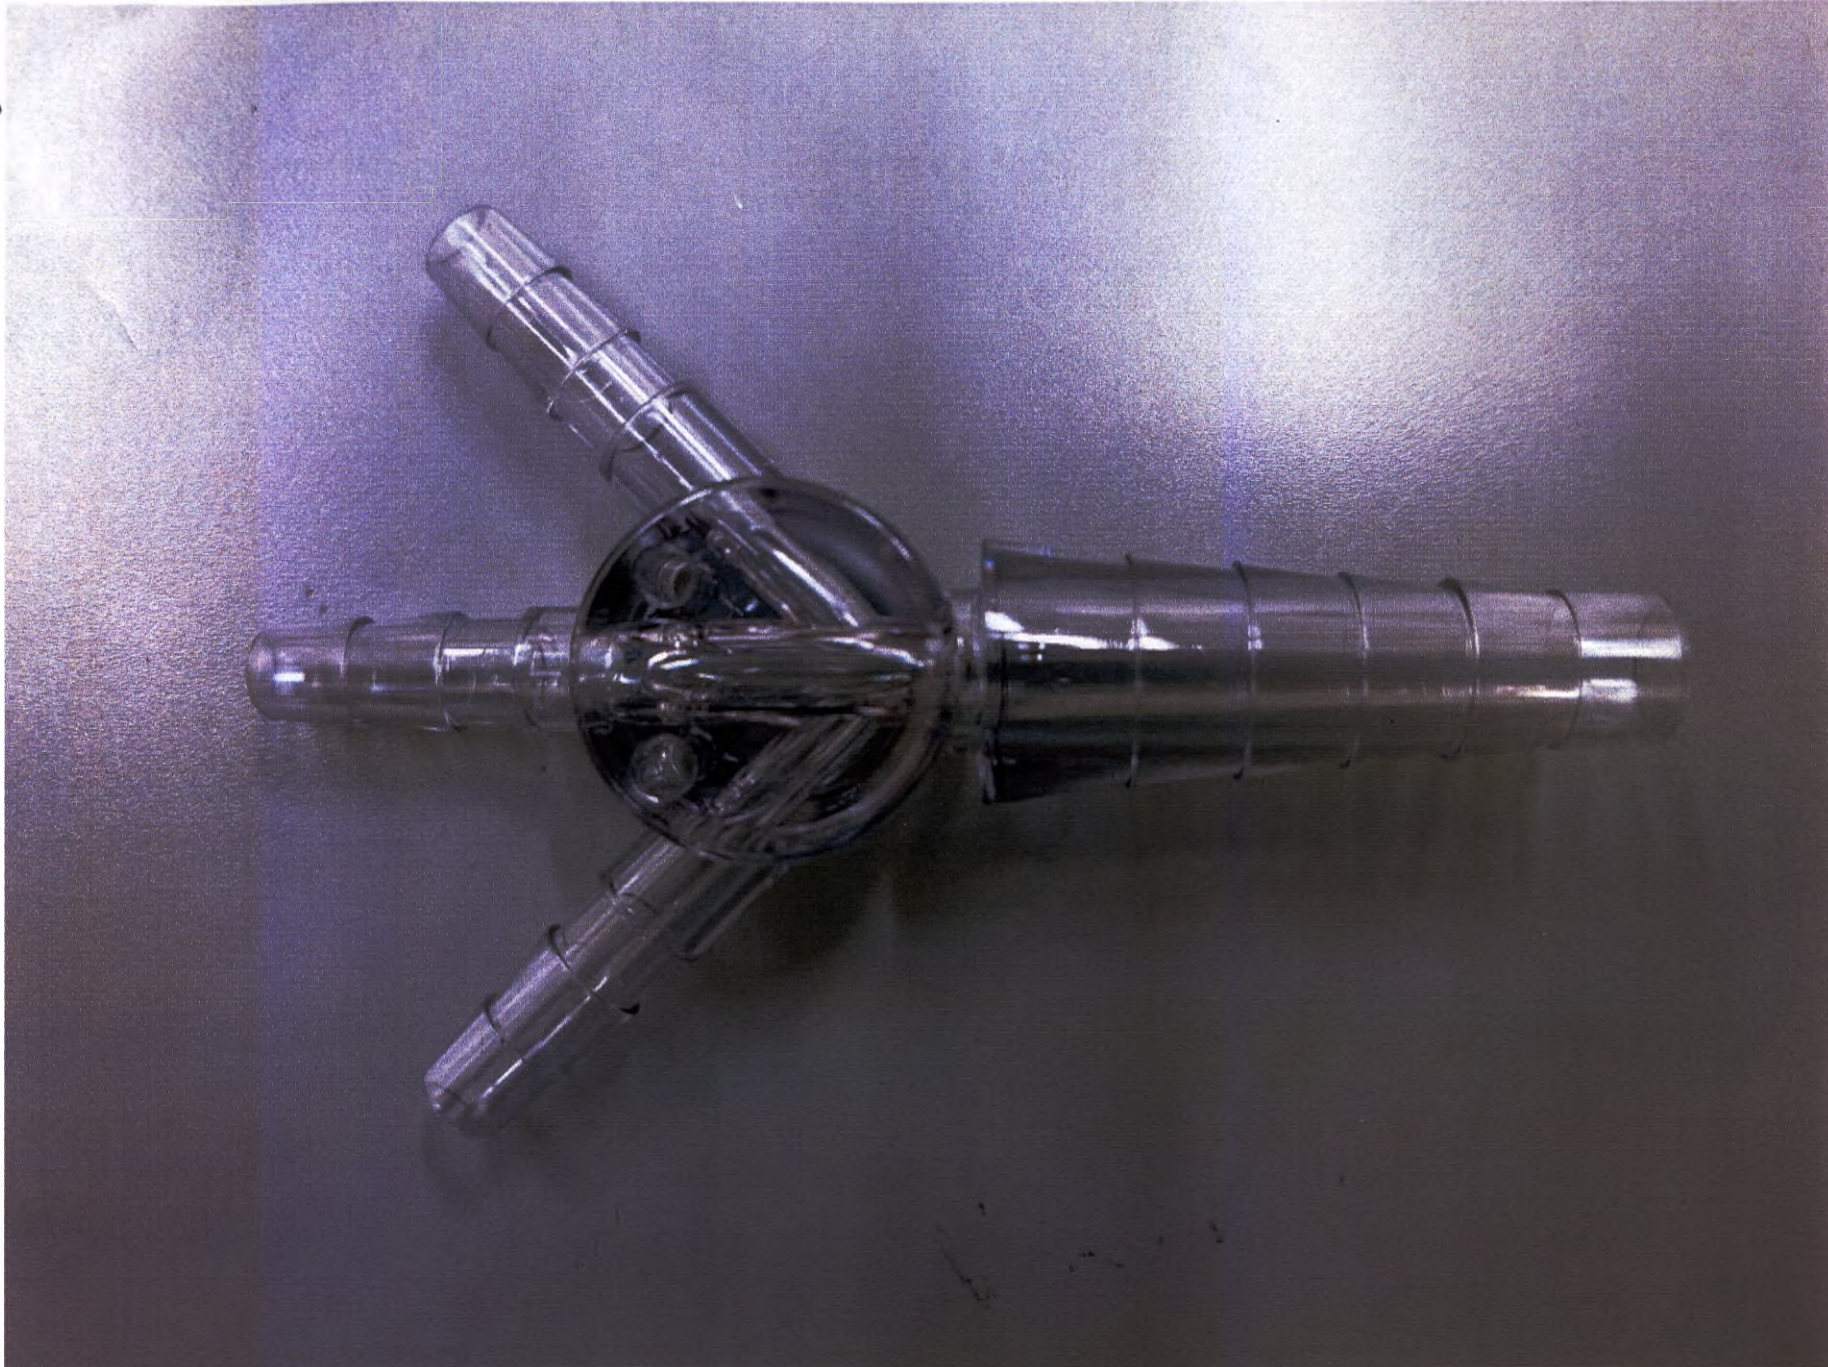

3.3. Кардиоконнектор Blake 3:1 (BCC3)

