

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов

« 28 » сентября 2023 г.




МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для определения концентрации трансферрина
в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
«ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-117-94568735-2022**

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.101

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 24 мл
Реагент №2: 1 x 1,6 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

LOT

Серия:
0013

Дата выпуска:
2022.02

Годен до:
2024.02

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK

TRANSFERRIN-VITAL

LOT

0013

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2024.02

R1: 1 x 24 ml
R2: 1 x 1,6 ml

IVD



42012206810041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF

B 42.01
B 42.101

РЕАГЕНТ 1

24 мл

LOT

0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Vital Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF

B 42.01
B 42.101

РЕАГЕНТ 2

1,6 мл

LOT

0013

Годен до: 2024.02


только для in vitro диагностики

Vital Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.01

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 24 мл
Реагент №2: 1 x 1,6 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 24 ml
R2: 1 x 1,6 ml
Calibrator : 1 x 0,5 ml

LOT 0013
2024.02

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56-A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



42012206610041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.01
REF B 42.101

РЕАГЕНТ 1

24 мл

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.01
REF B 42.101

РЕАГЕНТ 2

1,6 мл

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

0,5 мл

830 мг/дл(8,3 г/л)

LOT 0013


Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.111

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 48 мл
Реагент №2: 1 x 3,2 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

LOT

Серия: 0013

Дата выпуска: 2022.02

Годен до: 2024.02

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK

TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 48 ml

R2: 1 x 3,2 ml

LOT

0013

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2024.02

IVD



42112208610041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF

B 42.11

REF

B 42.111

REF

B 42.21

REF

B 42.121

48 мл

LOT

0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Vital

Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF

B 42.11

REF

B 42.111

REF

B 42.21

REF

B 42.121

3,2 мл

LOT

0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики


Vital

Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.11

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 48 мл
Реагент №2: 1 x 3,2 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 48 ml
R2: 1 x 3,2 ml
Calibrator : 1 x 0,5 ml

LOT 0013

2024.02

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A-194356
St. Petersburg, Russia

IVD



42112309150015

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121

48 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121

3,2 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

0,5 мл

830 мг/дл(8,3 г/л)

LOT 0013


годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.121

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 2 x 48 мл
Реагент №2: 2 x 3,2 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

LOT

Серия: 0013

Дата выпуска: 2022.02

ГОДЕН ДО: 2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 48 ml
R2: 2 x 3,2 ml

LOT 0013

годен до: 2024.02

Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk, 56 A 194356
St Petersburg, Russia

IVD



42212206610041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121

РЕАГЕНТ 1

48 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Vital Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121

РЕАГЕНТ 1

48 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Vital Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121

РЕАГЕНТ 2

3,2 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Vital Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121

РЕАГЕНТ 2

3,2 мл

LOT 0013


годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Vital Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.21

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 2 x 48 мл
Реагент №2: 2 x 3,2 мл
Калибратор: 2 x 0,5 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 48 ml
R2: 2 x 3,2 ml
Calibrator : 2 x 0,5 ml

LOT 0013
2024.02

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A 194355
St. Petersburg, Russia

IVD



42212208610041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121

48 мл
LOT 0013
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121

48 мл
LOT 0013
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121

3,2 мл
LOT 0013
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121


3,2 мл
LOT 0013
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР


0,5 мл
830 мг/дл(8,3 г/л)
LOT 0013
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ


КАЛИБРАТОР

0,5 мл
830 мг/дл(8,3 г/л)
LOT 0013
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF В 42.41

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 48 мл
 Реагент №2: 1 x 3,2 мл
 Калибратор: 1 x 0,5 мл
 Контроль (высокий уровень): 1x1,0 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02
 только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 58, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL
 R1: 1 x 48 ml
 R2: 1 x 3,2 ml
 Calibrator : 1 x 0,5 ml
 Control high : 1 x 1,0 ml IVD



42412208610041



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.41

РЕАГЕНТ 1

48 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.41

РЕАГЕНТ 2

3,2 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

0,5 мл

830 мг/дл(8,3 г/л)

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КОНТРОЛЬ

1,0 мл

248 (211-285) мг/дл

(2,48 (2,11-2,85) г/л)

высокий уровень

LOT 0013


годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.42

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 48 мл
 Реагент №2: 1 x 3,2 мл
 Калибратор: 1 x 0,5 мл
 Контроль (низкий уровень): 1x1,0 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02
 только для in vitro диагностики
 АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 48 ml
 R2: 1 x 3,2 ml
 Calibrator : 1 x 0,5 ml
 Control low : 1 x 1,0 ml

IVD



42422206610041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1 REF B 42.42
 48 мл
 LOT 0013
 Годен до: 2024.02
 только для in vitro диагностики
 Vital Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 2 REF B 42.42
 3,2 мл
 LOT 0013
 Годен до: 2024.02
 только для in vitro диагностики
 Vital Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР 0,5 мл
 830 мг/дл (8,3 г/л)
 LOT 0013
 Годен до: 2024.02
 только для in vitro диагностики
 Vital Development

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КОНТРОЛЬ 1,0 мл
 125 (106-144) мг/дл
 (1,25 (1,06-1,44) г/л)
 низкий уровень
 LOT 0013
 Годен до: 2024.02
 только для in vitro диагностики
 Vital Development

REF B 42.701-1.150

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 7 мл

ТУ 21.20.23-117-04860736-2022
РЗН 2022/18016 от 26.11.2022

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 40 ml
R2: 1 x 7 ml

LOT 0013

2024.02

IVD



427111501802120230



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.701-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики


Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.701-1.150

РЕАГЕНТ 2 7 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



REF В 42.71-1.150

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
трансферрина в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл ту 21.20.23-117-94568735-2022

Реагент №2: 1 x 7 мл РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 40 ml

R2: 1 x 7 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0013

2024.02

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk, 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



427111501802120230

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-1.150

РЕАГЕНТ 1

40 мл

LOT 0013



годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.71-1.150

РЕАГЕНТ 2 7 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР 0,5 мл

830 мг/дл(8,3 г/л)

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



REF В 42.701-1.200

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 2 x 20 мл
Реагент №2: 2 x 3,5 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

LOT

Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 20 ml
R2: 2 x 3,5 ml

LOT

0013



Vital Development Corporation
Corporation, Kamensk 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

Годен до: 2024.02

IVD



427112001802120230

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.200

20 мл



LOT

0013



годен до: 2024.02



только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.200

20 мл



LOT

0013



годен до: 2024.02



только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.200

3,5 мл



LOT

0013



годен до: 2024.02



только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.200

3,5 мл



LOT

0013



годен до: 2024.02



только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



РЕАГЕНТ 2



РЕАГЕНТ 2

REF В 42.71-1.200

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 20 мл ту 21.20.23-117-94568735-2022
 Реагент №2: 2 x 3,5 мл РЗН 2022/18916 от 25.11.2022
 Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02
 АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 20 ml

LOT 0013

R2: 2 x 3,5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

годен до: 2024.02

IVD

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-1.200

20 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-1.200

20 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



427112001802120230

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР 0,5 мл

830 мг/дл(8,3 г/л)

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-1.200

3,5 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-1.200

3,5 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 42.701-1.300

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 52 мл
Реагент №2: 1 x 9 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 52 ml
R2: 1 x 9 ml

LOT 0013

2024.02

IVD



427113001802120230

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.701-1.300

РЕАГЕНТ 2

9 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

REF В 42.71-1.300

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 52 мл ТУ 21.20.23-117-94568735-2022

Реагент №2: 1 x 9 мл РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 52 ml

LOT 0013

R2: 1 x 9 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

2024.02

IVD



427113001802120230

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-1.300



РЕАГЕНТ 1

52 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.71-1.300

9 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

0,5 мл

830 мг/дл(8,3 г/л)

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР



REF В 42.701-1.420

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 3 x 30 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022

Реагент №2: 3 x 5,5 мл

РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

LOT

Серия:

0013



Дата выпуска:

2022.02



Годен до:

2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 3 x 30 ml

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

R2: 3 x 5,5 ml

2024.02

IVD



427114201802120230

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

REF В 42.71-1.420

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 3 x 30 мл ту 21.20.23-117-94568735-2022
 Реагент №2: 3 x 5,5 мл РЗН 2022/18916 от 25.11.2022
 Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 3 x 30 ml R2: 3 x 5,5 ml
 Calibrator: 1 x 0,5 ml

2024.02

IVD



427114201802120230

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.71-1.420

30 мл

РЕАГЕНТ 1

2°C 8°C

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.71-1.420

30 мл

РЕАГЕНТ 1

2°C 8°C

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.71-1.420

30 мл

РЕАГЕНТ 1


2°C 8°C

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

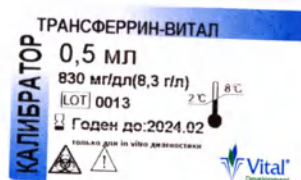

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.71-1.420

5,5 мл

РЕАГЕНТ 2

2°C 8°C

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.71-1.420

5,5 мл

РЕАГЕНТ 2

2°C 8°C

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.71-1.420

5,5 мл

РЕАГЕНТ 2

2°C 8°C

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 42.701-2.200

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 2 x 37 мл
Реагент №2: 2 x 5,5мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

LOT Серия: 0013
Дата выпуска: 2022.02
Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 37 ml
R2: 2 x 5,5ml

LOT 0013

годен до: 2024.02

IVD



427122001802120230

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.701-2.200

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.701-2.200

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-2.200

РЕАГЕНТ 1 37 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-2.200

РЕАГЕНТ 1 37 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 42.71-2.200

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 37 мл
Реагент №2: 2 x 5,5 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Серия: 0013
Дата выпуска: 2022.02
Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 37 ml

R2: 2 x 5,5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0013

2024.02

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-2.200

РЕАГЕНТ 1 37 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-2.200

РЕАГЕНТ 1 37 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.71-2.200

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.71-2.200

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР 0,5 мл

830 мг/дл(8,3 г/л)

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент

REF В 42.701-2.300

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 41 мл
Реагент №2: 1 x 6,7 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

LOT Серия: 0013
Дата выпуска: 2022.02
Годен до: 2024.02
АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 41 ml
R2: 1 x 6,7 ml

LOT 0013

2024.02

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



427123001802120230

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-2.300

РЕАГЕНТ 1

41 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.701-2.300

РЕАГЕНТ 2 6,7 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

REF В 42.71-2.300

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 41 мл ТУ 21.20.23-117-94568735-2022

Реагент №2: 1 x 6,7 мл РЗН 2022/18916 от 25.11.2022

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия 194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 41 ml

R2: 1 x 6,7 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

Годен до: 2024.02

IVD



427123001802120230

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-2.300

РЕАГЕНТ 1

41 мл

LOT 0013



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.71-2.300

РЕАГЕНТ 2 6,7 мл

LOT 0013



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

КАЛИБРАТОР

0,5 мл

830 мг/дл(8,3 г/л)

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью



Всего 21 листа(ов)

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
А.Г.Плехов
« 20 » сентября 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина
в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом
«ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-117-94568735-2022

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.101

Набор реагентов для определения концентрации
трансферрина в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 24 мл
Реагент №2: 1 x 1,6 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РУ

LOT Серия:
0013



Дата выпуска:
2022.02



Годен до:
2024.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

LOT 0013

R1: 1 x 24 ml
R2: 1 x 1,6 ml

2024.02



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

IVD




42012206610041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.01 B 42.101
24 мл 2°C 8°C
LOT 0013
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики
Vital

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.01 B 42.101
1,6 мл 2°C 8°C
LOT 0013
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики
Vital

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.01

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 24 мл
Реагент №2: 1 x 1,6 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РУ

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

UK

TRANSFERRIN-VITAL

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

R1: 1 x 24 ml

R2: 1 x 1,6 ml

Calibrator : 1 x 0,5 ml



2024.02

IVD



42012208610041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

РЕАГЕНТ 1

REF B 42.01
REF B 42.101

24 мл

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.111

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 48 мл
Реагент №2: 1 x 3,2 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РУ

LOT Серия:
0013



Дата выпуска:
2022.02



Годен до:
2024.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia


R1: 1 x 48 ml
R2: 1 x 3,2 ml

2024.02

IVD



42112206610041

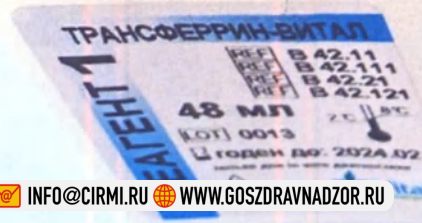

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.11

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 48 мл
Реагент №2: 1 x 3,2 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РУ

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 48 ml
R2: 1 x 3,2 ml
Calibrator : 1 x 0,5 ml

LOT

0013



2024.02



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD



42112208610041


ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121
48 мл
LOT 0013
Годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики
Vital



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.121

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 2 x 48 мл
Реагент №2: 2 x 3,2 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РУ

LOT Серия:
0013



Дата выпуска:
2022.02



Годен до:
2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 48 ml
R2: 2 x 3,2 ml

LOT 0013

2024.02

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD





42212206810041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ
REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121
48 мл
LOT 0013
2°C 8°C
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики
Vital

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ
REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121
48 мл
LOT 0013
2°C 8°C
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики
Vital

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ
REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121
3,2 мл
LOT 0013
2°C 8°C
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики
Vital

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ
REF B 42.11
REF B 42.111
REF B 42.21
REF B 42.121
2 мл
LOT 0013
2°C 8°C
годен до: 2024.02
только для in vitro диагностики
Vital

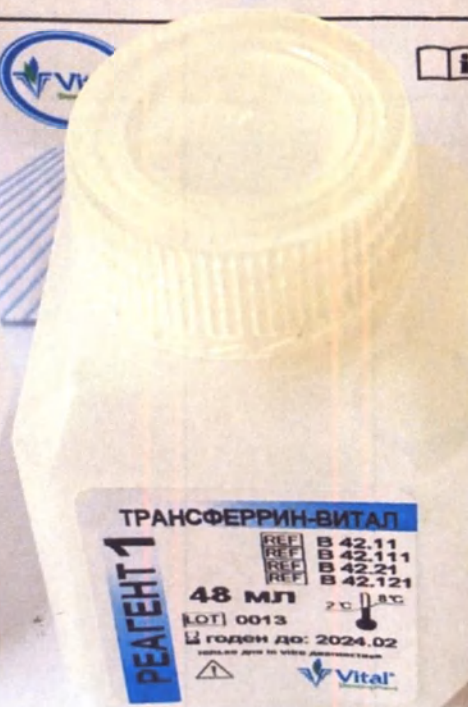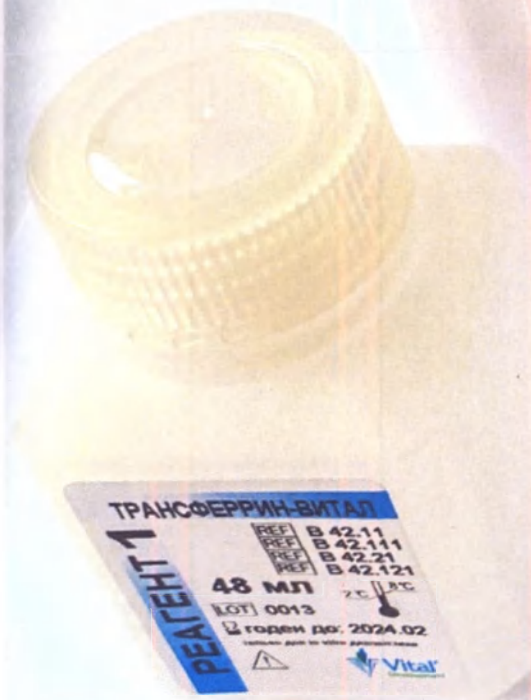

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.41

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови имунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 48 мл
Реагент №2: 1 x 3,2 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл
Контроль (высокий уровень): 1x1,0 мл
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РУ

LOT Серия: 0013 Дата выпуска: 2022.02 Годен до: 2024.02

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 58, литера А


только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 48 ml
R2: 1 x 3,2 ml
Calibrator : 1 x 0,5 ml
Control high : 1 x 1,0 ml

LOT 0013
2024.02

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 58 A, 194356
St Petersburg, Russia



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.42

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 48 мл
Реагент №2: 1 x 3,2 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл
Контроль (низкий уровень): 1x1,0 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
РУ

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2022.02



Годен до:
2024.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 48 ml
R2: 1 x 3,2 ml
Calibrator : 1 x 0,5 ml
Control low : 1 x 1,0 ml

LOT

0013



2024.02



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

IVD





42422206610041

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ REF B 42.42

48 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

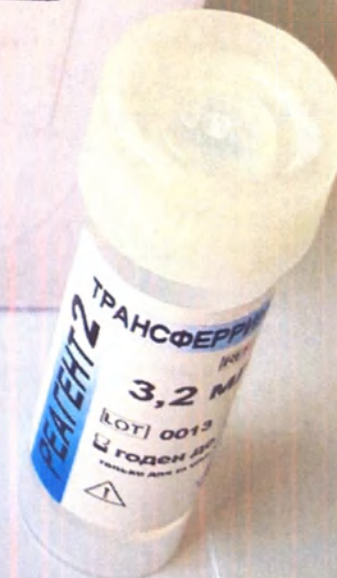

REF В 42.701-1.150

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 40 мл

РУ

Реагент №2: 1 x 7 мл

LOT

Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 40 ml

R2: 1 x 7 ml

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk 56 A 194356
St. Petersburg, Russia

2024.02

IVD

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.150

40 мл



LOT

0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.150

2

7 мл



LOT


0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



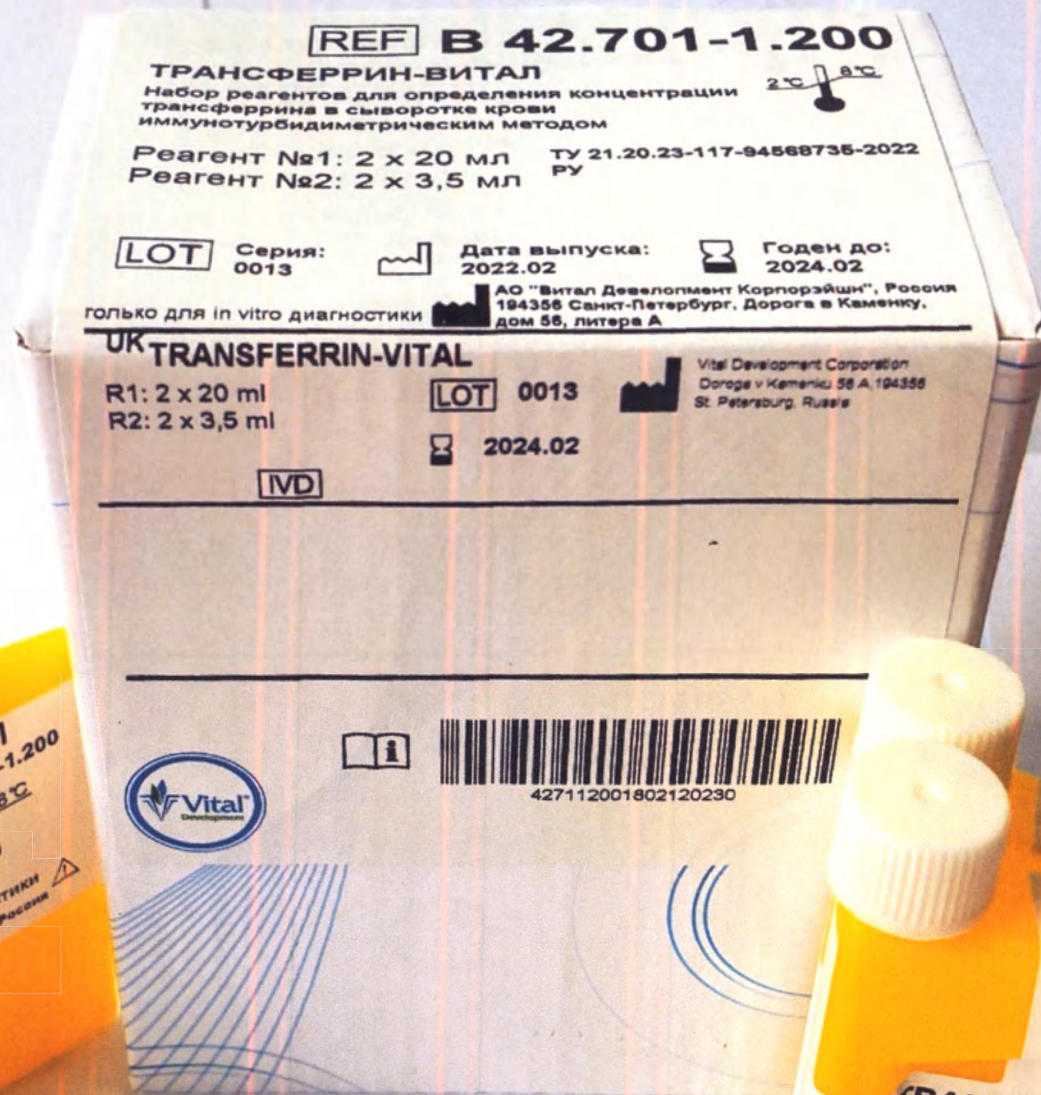

REF В 42.71-1.200

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 20 мл ту 21.20.23-117-94568735-2022

Реагент №2: 2 x 3,5 мл РУ

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 20 ml

R2: 2 x 3,5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.02

IVD



427112001802120230



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ
REF В 42.71-1.200

РЕАГЕНТ 1
20 МЛ

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ
REF В 42.71-1.200

РЕАГЕНТ 2
3,5 МЛ

LOT 0013


годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 42.701-1.300

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 52 мл ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
Реагент №2: 1 x 9 мл РУ

LOT

Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 52 ml
R2: 1 x 9 ml

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenskuyu 56 A, 194355
St. Petersburg, Russia



2024.02

IVD



427113001802120230



ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.300

9 мл



LOT 0013

Годен до: 2024.02


только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.300

52 мл



LOT

0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики



Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 42.71-1.300

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 52 мл

Реагент №2: 1 x 9 мл

Калибратор: 1 x 0,5 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022
ру

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT Серия: 0013

Дата выпуска: 2022.02

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 52 ml

R2: 1 x 9 ml

Calibrator: 1 x 0.5 ml


LOT 0013

Годен до: 2024.02

IVD



427113001802120230

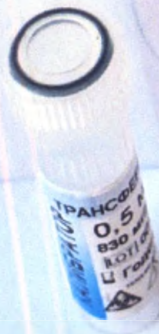

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-1.300

52 мл

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-1.300

9 мл

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 42.701-1.420

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 3 x 30 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022

Реагент №2: 3 x 5,5 мл

РУ

LOT

Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 3 x 30 мл

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenuk 56 A, 194356
St. Petersburg

R2: 3 x 5,5 мл

2024.02

IVD

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия



4271142018

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл

LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент Корпорейшн, Россия

REF В 42.71-1.420

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
трансферрина в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 3 x 30 мл ту 21.20.23-117-94568735-2022
Реагент №2: 3 x 5,5 мл ру
Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2022.02



Годен до:
2024.02

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

только для in vitro диагностики

UK

TRANSFERRIN-VITAL

R1: 3 x 30 ml
R2: 3 x 5,5 ml
Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT 0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

2024.02

IVD



427114201802120230



**ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ**

REF В 42.71-1.420

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл



LOT 0013

Годен до: 2024.02


только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

**ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ**

REF В 42.71-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл



LOT 0013

Годен до: 2024.02


только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

**ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ**

REF В 42.71-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл



LOT 0013

Годен до: 2024.02


только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

**ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ**

REF В 42.71-1.420

РЕАГЕНТ 1 30 мл



LOT 0013

Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики


Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



REF В 42.701-2.200

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
трансферрина в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 2 x 37 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022

Реагент №2: 2 x 5,5мл

РУ

LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2022.02



Годен до:
2024.02

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 37 ml

R2: 2 x 5,5ml

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia




2024.02

IVD

**ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ**

REF В 42.701-2.200

2 5,5 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия




427122001802120230

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-2.200

РЕАГЕНТ 1

37 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия

REF В 42.71-2.200

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 2 x 37 мл ТУ 21.20.23-117-94568735-2022

Реагент №2: 2 x 5,5 мл РУ

Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 2 x 37 ml

R2: 2 x 5,5 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT

0013



2024.02

IVD

Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ
REF В 42.71-2.200

РЕАГЕНТ 1 37 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн, Россия



427122001802120230



ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ

REF В 42.71-2.200

РЕАГЕНТ 2 5,5 мл

LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики


Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



REF В 42.701-2.300

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации
трансферрина в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом



Реагент №1: 1 x 41 мл

ТУ 21.20.23-117-94568735-2022

Реагент №2: 1 x 6,7 мл

РУ

LOT

Серия:
0013



Дата выпуска:
2022.02



Годен до:
2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK

TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 41 ml

R2: 1 x 6,7 ml

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamensk 56 A. 194356
St. Petersburg, Russia



2024.02

IVD



427123001802120230



**ТРАНСФЕРРИН
ВИТАЛ**

REF В 42.71-2.300
2 6,7 мл



LOT 0013

годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики
Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.71-2.300

41 мл

LOT

0013



годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

REF В 42.71-2.300

ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом

Реагент №1: 1 x 41 мл
Реагент №2: 1 x 6,7 мл
Калибратор: 1 x 0,5 мл

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия: 0013



Дата выпуска: 2022.02



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

UK TRANSFERRIN-VITAL

R1: 1 x 41 ml

R2: 1 x 6,7 ml

Calibrator: 1 x 0,5 ml

LOT

0013



Vital Development Corporation
Doroga v Kamenu, 56 A, 194356
St. Petersburg, Russia



2024.02

IVD

ТРАНСФЕРРИН ВИТАЛ

REF В 42.701-2.300

2 6,7 мл



LOT 0013

Годен до: 2024.02

Витал Девелопмент
Корпорэйшн, Россия



427123001802120230




ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ

REF В 42.701-2.300

41 мл

LOT

0013



Годен до: 2024.02

только для in vitro диагностики

Витал Девелопмент Корпорэйшн,
Россия

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 21 листа(ов)



Ген. директор

Плехов А.Г.