

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор  
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

2022 г.

Образцы маркировки

Набор реагентов для иммуноферментного определения  
антител к Eпv антигенам ВИЧ ½ (групп М и О ВИЧ-1)  
«АнтиВИЧ-1/2-Eпv-ИМБИАН-ИФА»  
по ТУ 21.20.23-359-41390295-2022

1. Образцы этикеток компонентов набора «АнтиВИЧ-1/2-Eпv-ИМБИАН-ИФА»  
Комплекты №№ 1-2

| Наименование компонента                                   | Этикетка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иммуносорбент                                             | <div><p><b>АнтиВИЧ-1/2-Eпv-ИМБИАН-ИФА</b></p><p><b>Иммуносорбент</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p><p>96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными Eпv антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2</p><p>LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД</p><p></p></div> |
| К(+) – инактивированный положительный контрольный образец | <div><p><b>АнтиВИЧ-1/2-Eпv-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p><p><b>К(+) - 1,0 мл</b><br/>(Инактивирован)</p><p>LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД   2°C </p></div>                                                                                                                                                                  |
| К(-) – инактивированный отрицательный контрольный образец | <div><p><b>АнтиВИЧ-1/2-Eпv-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p><p><b>К(-) - 2,0 мл</b><br/>(Инактивирован)</p><p>LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД   2°C </p></div>                                                                                                                                                                  |



|                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФСБ-Т(х26) – концентрат промывочного раствора | <div> <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»         </div> <div> <b>ФСБ-Т(х26) - 30,0 мл</b> </div> <div>           LOT XXXXXX            ГГГГ-ММ-ДД             2°C            </div>   |
| РК – раствор конъюгата                        | <div> <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»         </div> <div> <b>РК - 7,0 мл</b> </div> <div>           LOT XXXXXX            ГГГГ-ММ-ДД             2°C            </div>            |
| ТМБ – раствор тетраметилбензидина             | <div> <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»         </div> <div> <b>ТМБ - 13,0 мл</b> </div> <div>           LOT XXXXXX            ГГГГ-ММ-ДД             2°C            </div>          |
| Стоп-реагент                                  | <div> <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»         </div> <div> <b>Стоп-реагент - 7,0 мл</b> </div> <div>           LOT XXXXXX            ГГГГ-ММ-ДД             2°C             </div> |

## 2. Образцы этикеток компонентов набора «АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА» Комплект №3

| Наименование компонента | Этикетка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иммуносорбент           | <div> <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> </div> <div> <b>Иммуносорбент</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»         </div> <div>           96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными Env антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2         </div> <div>           LOT XXXXXX            ГГГГ-ММ-ДД                 2°C            </div> |



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К(+)<br>– инактивированный положительный<br>контрольный образец | <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»<br><br><b>К(+)<br/>- 5,0 мл</b><br>(Инактивирован)<br><br>LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД   20°C  IVD  |
| К(-)<br>– инактивированный отрицательный<br>контрольный образец | <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»<br><br><b>К(-)<br/>- 10,0 мл</b><br>(Инактивирован)<br><br>LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД   20°C  IVD |
| ФСБ-Т(х26)<br>– концентрат промывочного<br>раствора             | <b>АнтиВИЧ 1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»<br><br><b>ФСБ-Т(х26)<br/>- 250,0 мл</b><br><br>LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД  20°C  IVD                                                                                                 |
| РК – раствор конъюгата                                          | <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»<br><br><b>РК - 31,0 мл</b><br><br>LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД  20°C  IVD                                                                                                          |
| ТМБ – раствор тетраметилбензидина                               | <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»<br><br><b>ТМБ - 61,0 мл</b><br><br>LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД  20°C   IVD                   |
| Стоп-реагент                                                    | <b>АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА</b> ООО «ИМБИАН ЛАБ»<br><br><b>Стоп-реагент - 31,0 мл</b><br><br>LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД  20°C   IVD          |



2. Образцы этикеток шоу-бокса набора «АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА»  
2.1. Образец боковой этикетки



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2



Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7



8-800-600-90-77  
www.imbian.ru  
info@imbian.ru  
WhatsApp: +73832093454

2.2. Образец основной этикетки  
2.2.1. Комплект 1

**АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА**  
**Комплект №1**

**Набор реагентов содержит:**

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1,0 мл)
- 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)
- 4 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 5 РК - раствор конъюгата (7,0 мл)
- 6 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 7 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 8 Пленка для заклеивания планшета
- 9 Ванночки для реагентов
- 10 Наконечники для пипеток
- 11 Инструкция по применению набора реагентов

**Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к Env антигенам ВИЧ 1/2 (групп М и О ВИЧ-1) «АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-359-41390295-2022**  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

|            |            |
|------------|------------|
| LOT        | XXXXXX     |
| REF        | SE-015/96  |
| ГТТГ-ММ-ДД | ГТТГ-ММ-ДД |
| ГТТГ-ММ-ДД | ГТТГ-ММ-ДД |



4 620102 803864

ООО «ИМБИАН ЛАБ»  
630559, Новосибирская область,  
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7,  
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,  
info@imbian.ru

Для профессионального применения  
Для клинической лабораторной диагностики  
Замораживание не допускается.  
Антитела к вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют



2.2.2. Комплект 2

**АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА**  
**Комплект №2**

**Набор реагентов содержит:**

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1,0 мл)
- 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)
- 4 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 5 РК - раствор конъюгата (7,0 мл)
- 6 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 7 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 8 Пленка для заклеивания планшета
- 9 Ванночки для реагентов
- 10 Наконечники для пипеток
- 11 Инструкция по применению набора реагентов

**Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к Env антигенам ВИЧ 1/2 (групп М и О ВИЧ-1) «АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-359-41390295-2022**  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

|            |            |
|------------|------------|
| LOT        | XXXXXX     |
| REF        | SE-015/192 |
| ГТТГ-ММ-ДД | ГТТГ-ММ-ДД |
| ГТТГ-ММ-ДД | ГТТГ-ММ-ДД |



4 620102 803871

ООО «ИМБИАН ЛАБ»  
630559, Новосибирская область,  
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7,  
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,  
info@imbian.ru

Для профессионального применения  
Для клинической лабораторной диагностики  
Замораживание не допускается.  
Антитела к вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют





# АнтиВИЧ-1/2-Env- ИМБИАН-ИФА Комплект №3

**Набор реагентов для иммуноферментного определения  
антител к Env антигенам ВИЧ 1/2 (групп М и О ВИЧ-1)  
«АнтиВИЧ-1/2-Env-ИМБИАН-ИФА»  
по ТУ 21.20.23-359-41390295-2022**

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

## Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (5,0 мл)
- 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (10,0 мл)
- 4 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (250,0 мл)
- 5 РК - раствор конъюгата (31,0 мл)
- 6 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (61,0 мл)
- 7 Стоп-реагент (31,0 мл)
- 8 Пленка для заклеивания планшета
- 9 Ванночки для реагентов
- 10 Наконечники для пипеток
- 11 Инструкция по применению набора реагентов

5 шт  
1 фл  
1 фл  
1 фл  
1 фл  
1 фл  
1 фл  
10 шт  
10 шт  
80 шт  
1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX


REF SE-015/480

ГТТГ-ММ-ДД

ГТТГ-ММ-ДД



Для профессионального применения  
Для клинической лабораторной диагностики  
Замораживание не допускается.  
Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



ООО «ИМБИАН ЛАБ»  
630559, Новосибирская область,  
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7,  
8 (383) 209-34-54, 8-800-600-90-77,  
info@mbian.ru

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

лист 5

Генеральный директор  
ООО «ИМЕИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"16" Вос 2022 г.






Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для иммуноферментного определения  
антител к Gag антигенам ВИЧ 1/2 (групп М и О ВИЧ-1)


«АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА»

по ТУ 21.20.23-237-41390295-2022

Комплект №1:

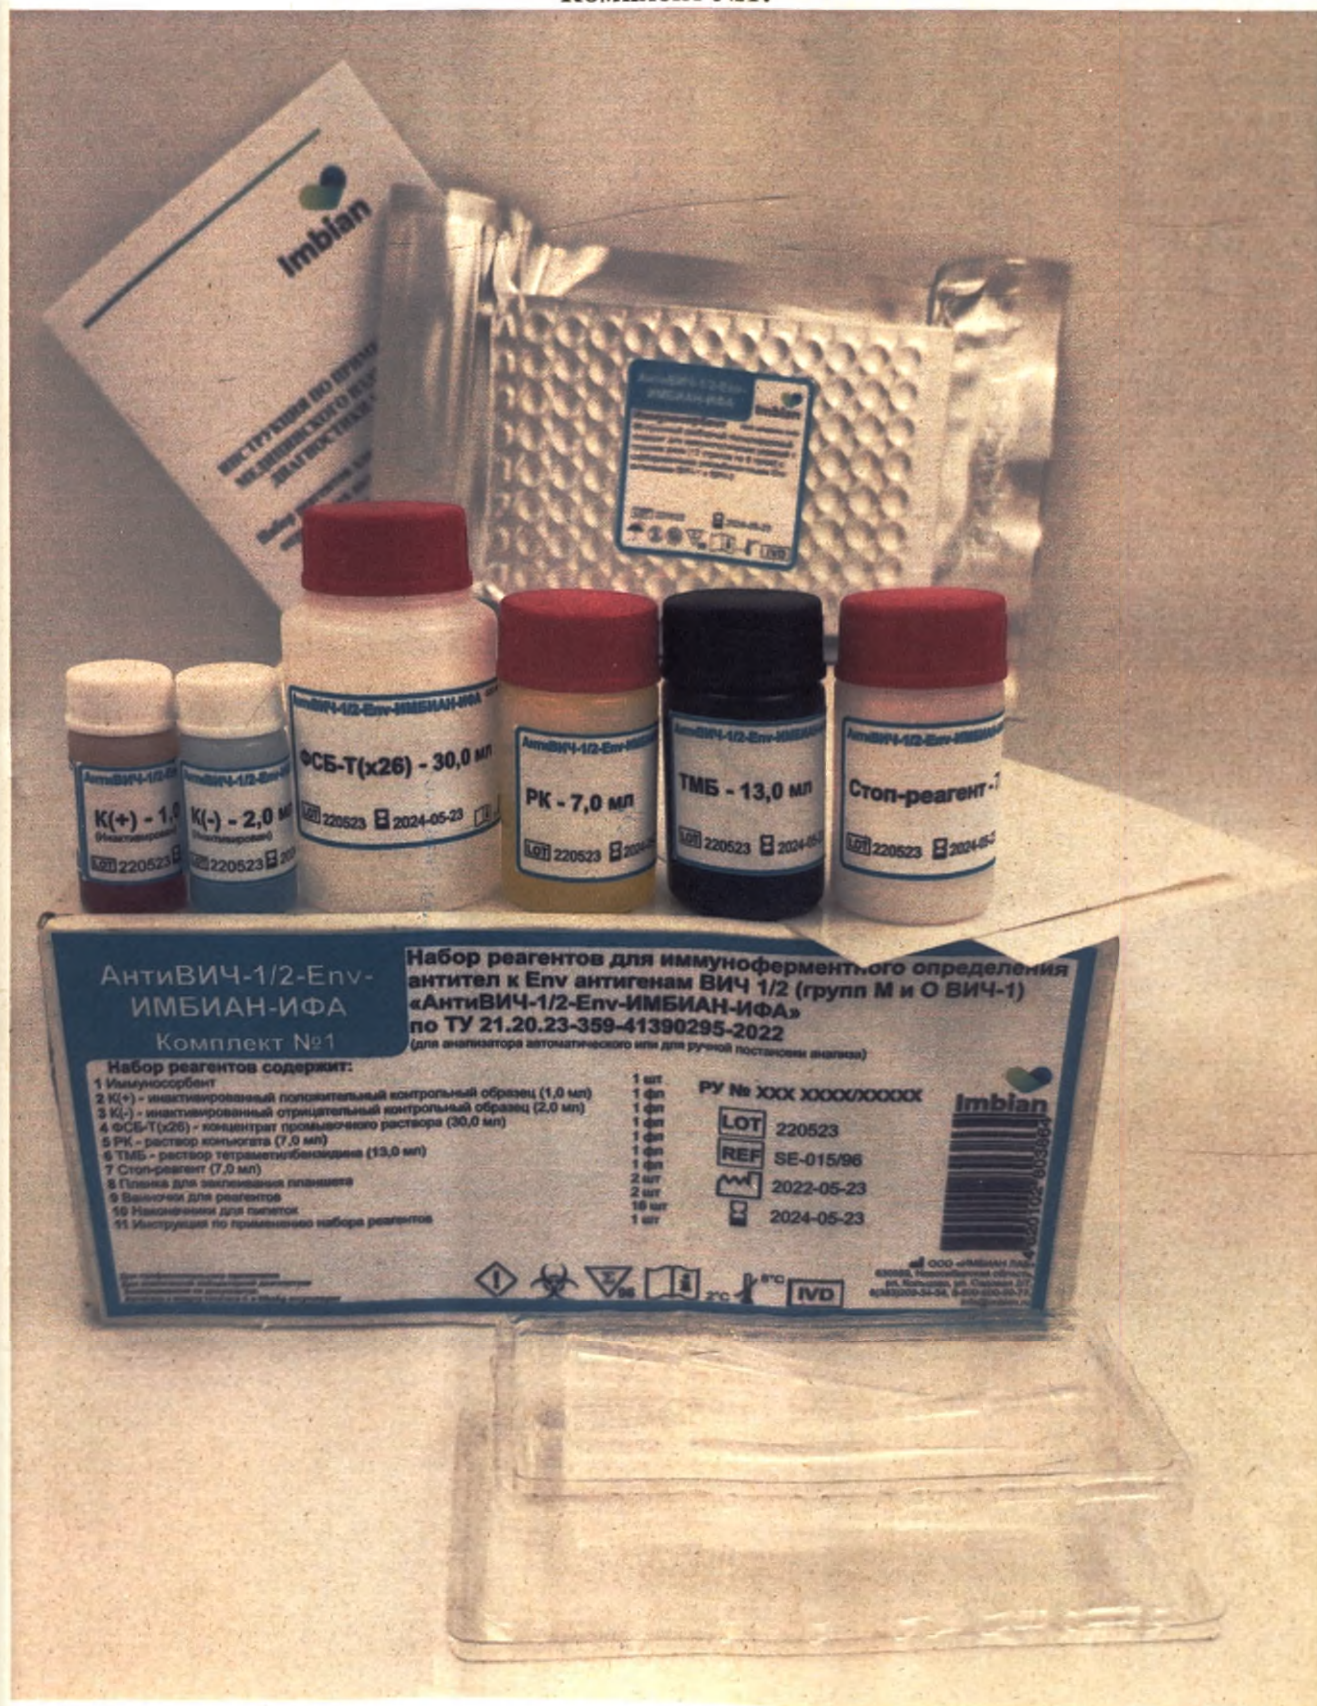



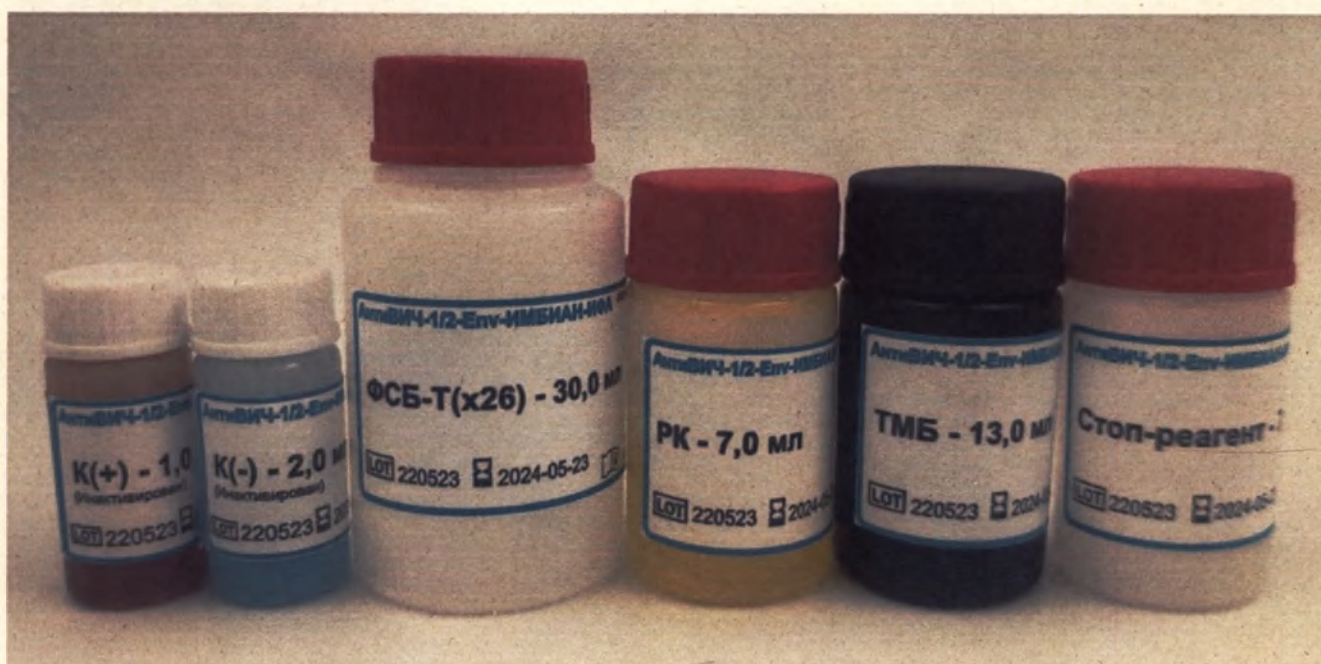













# Комплект №3:

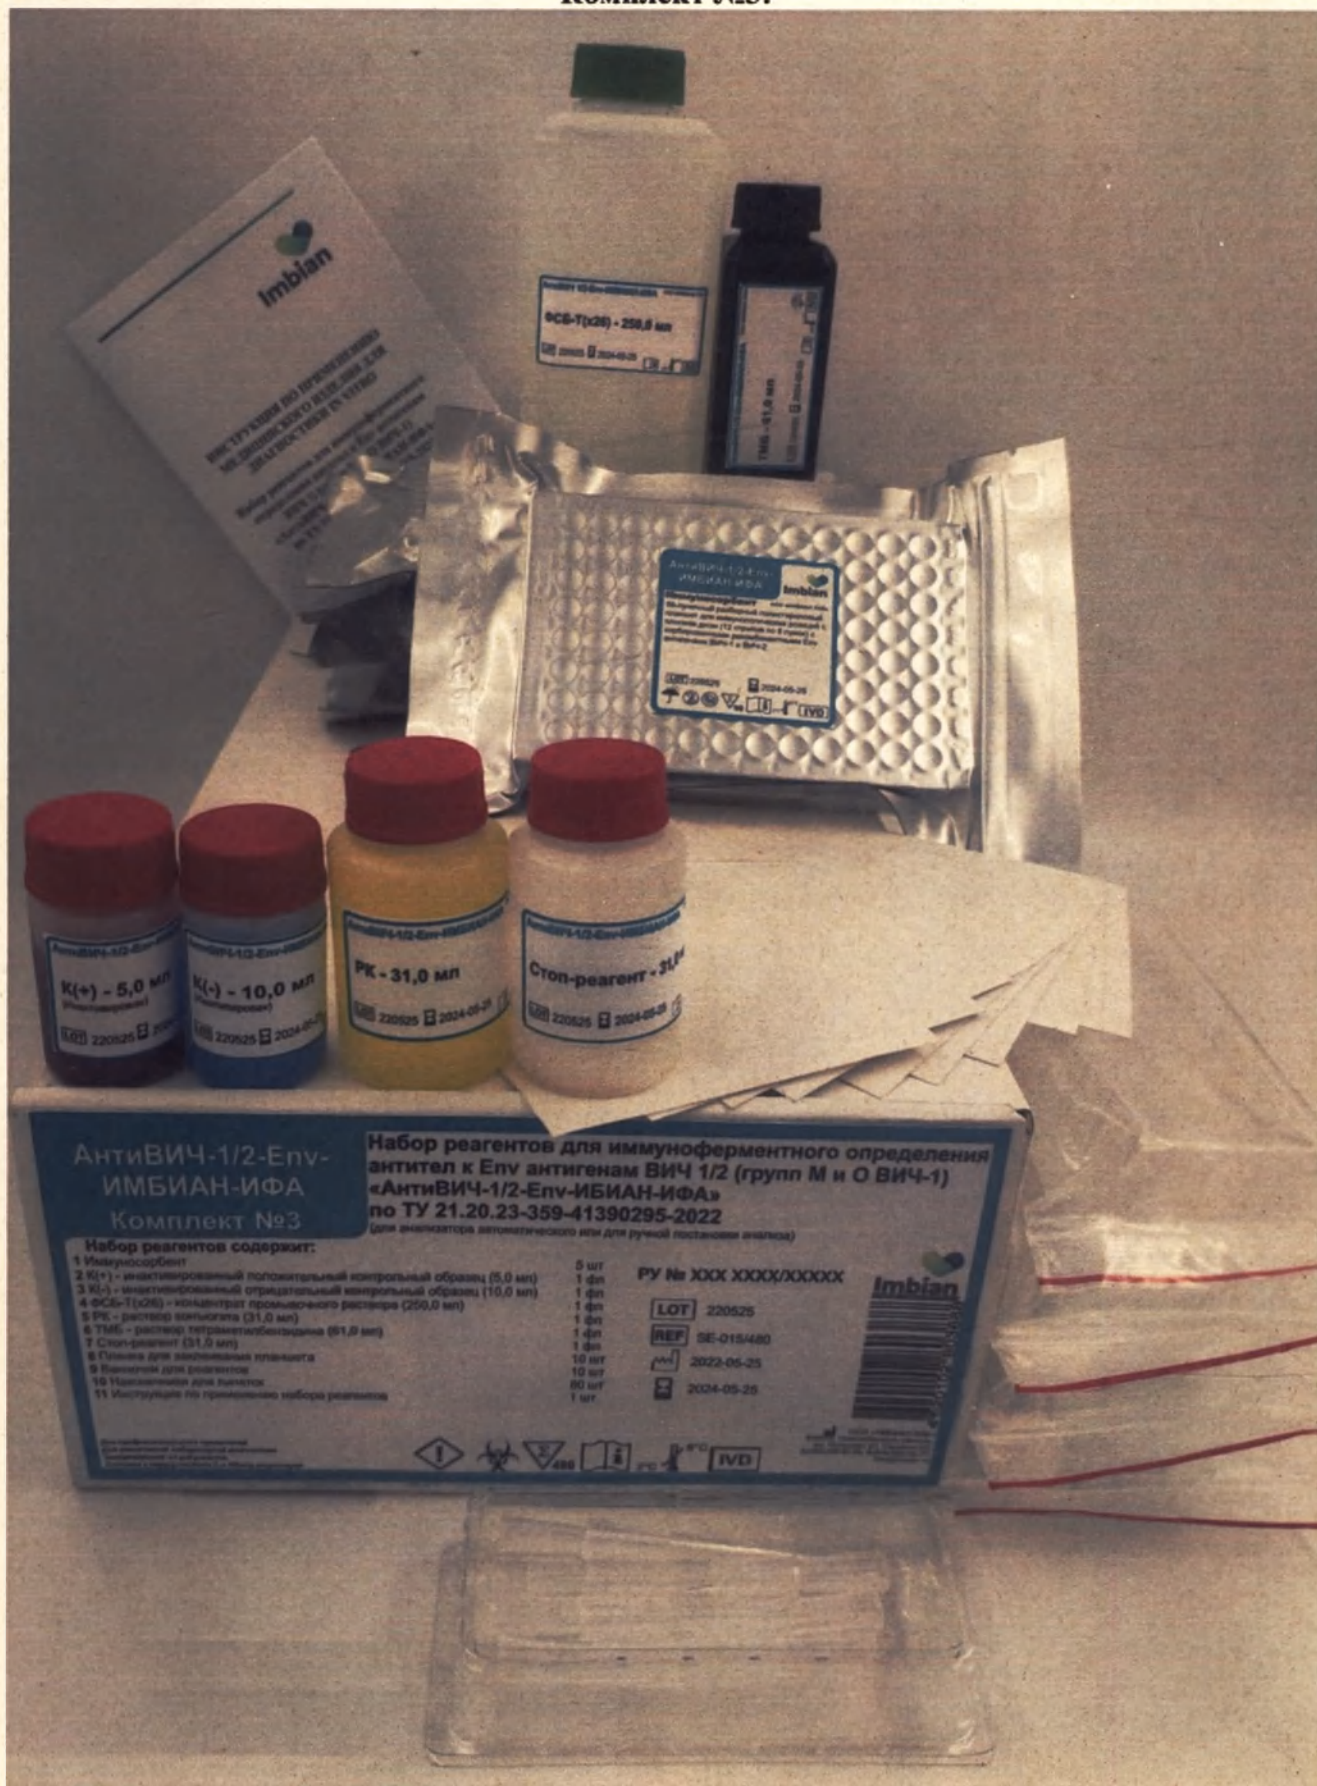



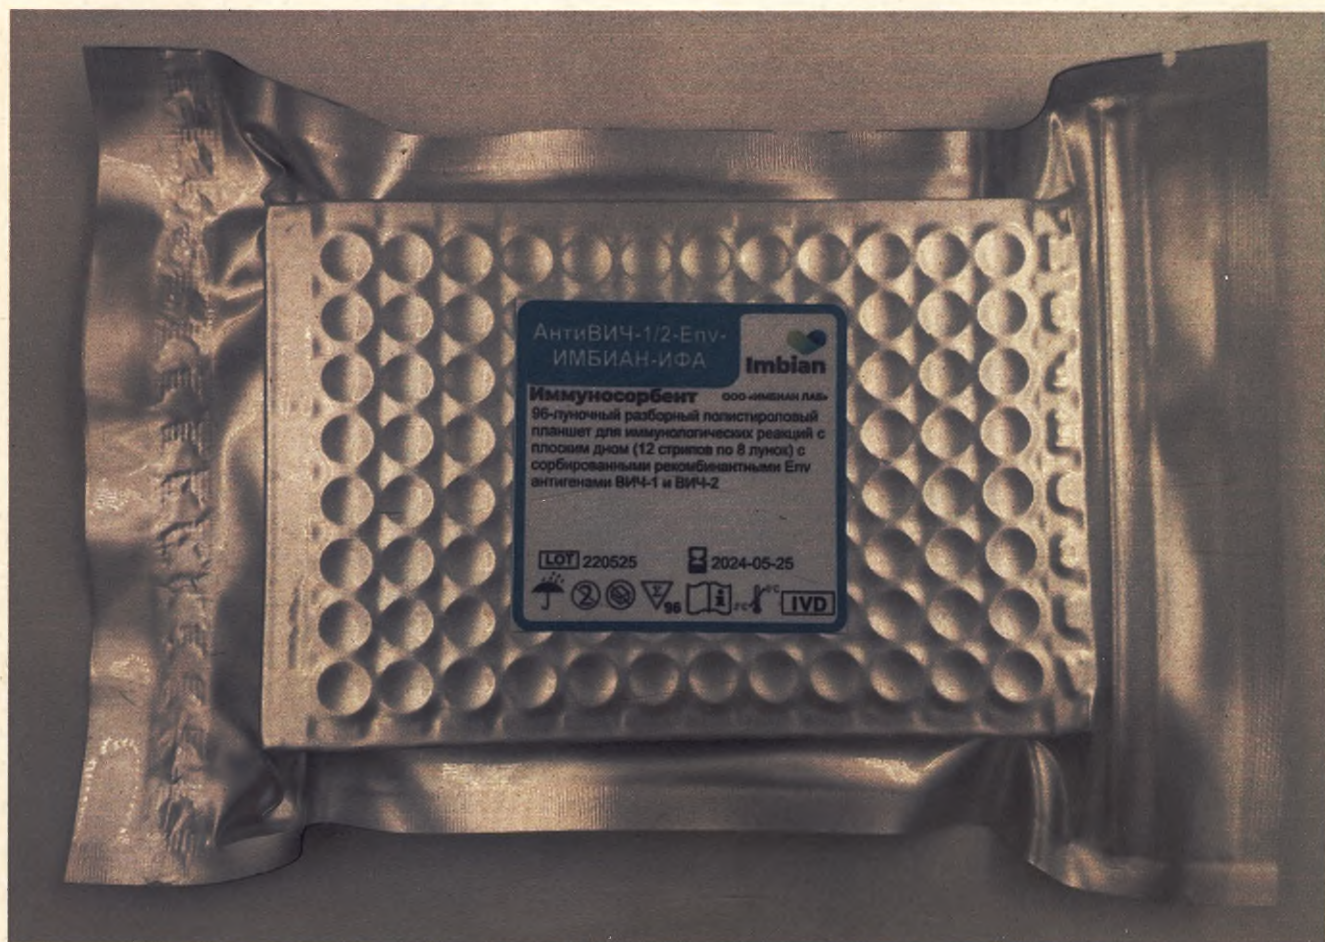

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

«16» сентября 2022 г.

В.В. Осипова





Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

6 лист

Генеральный директор  
ООО «ЦИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"26" 09 2022 г.

