

**МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА
ИСПОЛНЕНИЯ**

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX (диаметр баллона 9/12 мм, порт для инъекции выше баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 3 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX (диаметр баллона 12/15 мм, порт для инъекции выше баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 5 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX (диаметр баллона 15/18 мм, порт для инъекции выше баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 10 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX (диаметр баллона 9/12 мм, порт для инъекции ниже баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 3 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX (диаметр баллона 12/15 мм, порт для инъекции ниже баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 5 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для однократного использования

**Нетоксично
Апирогенно**

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/labeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX (диаметр баллона 15/18 мм, порт для инъекции ниже баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 10 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для однократного использования

**Нетоксично
Апирогенно**

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/labeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro XL (диаметр баллона 9/12 мм, порт для инъекции выше баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 3 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для однократного использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro XL (диаметр баллона 12/15 мм, порт для инъекции выше баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 5 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для однократного использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro XL (диаметр баллона 15/18 мм, порт для инъекции выше баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 10 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro XL (диаметр баллона 9/12 мм, порт для инъекции ниже баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 3 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro XL (диаметр баллона 12/15 мм, порт для инъекции ниже баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 5 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro XL (диаметр баллона 15/18 мм, порт для инъекции ниже баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 10 мл – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX-S (диаметр баллона 9/12 мм, порт для инъекции выше баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 3 мл – 1 шт.
- Стиллет – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для однократного использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX-S (диаметр баллона 12/15 мм, порт для инъекции выше баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 5 мл – 1 шт.
- Стиллет – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для однократного использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX-S (диаметр баллона 15/18 мм, порт для инъекции выше баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 10 мл – 1 шт.
- Стиллет – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX-S (диаметр баллона 9/12 мм, порт для инъекции ниже баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 3 мл – 1 шт.
- Стиллет – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX-S (диаметр баллона 12/15 мм, порт для инъекции ниже баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 5 мл – 1 шт.
- Стиллет – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX-S (диаметр баллона 15/18 мм, порт для инъекции ниже баллона), в составе:

- Катетер баллонный – 1 шт.
- Кран запорный – 1 шт.
- Шприц объемом 10 мл – 1 шт.
- Стиллет – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично
Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
10 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.






ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro, в вариантах исполнения


Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX, в вариантах исполнения




Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX в упаковке (пакете) (вид спереди)

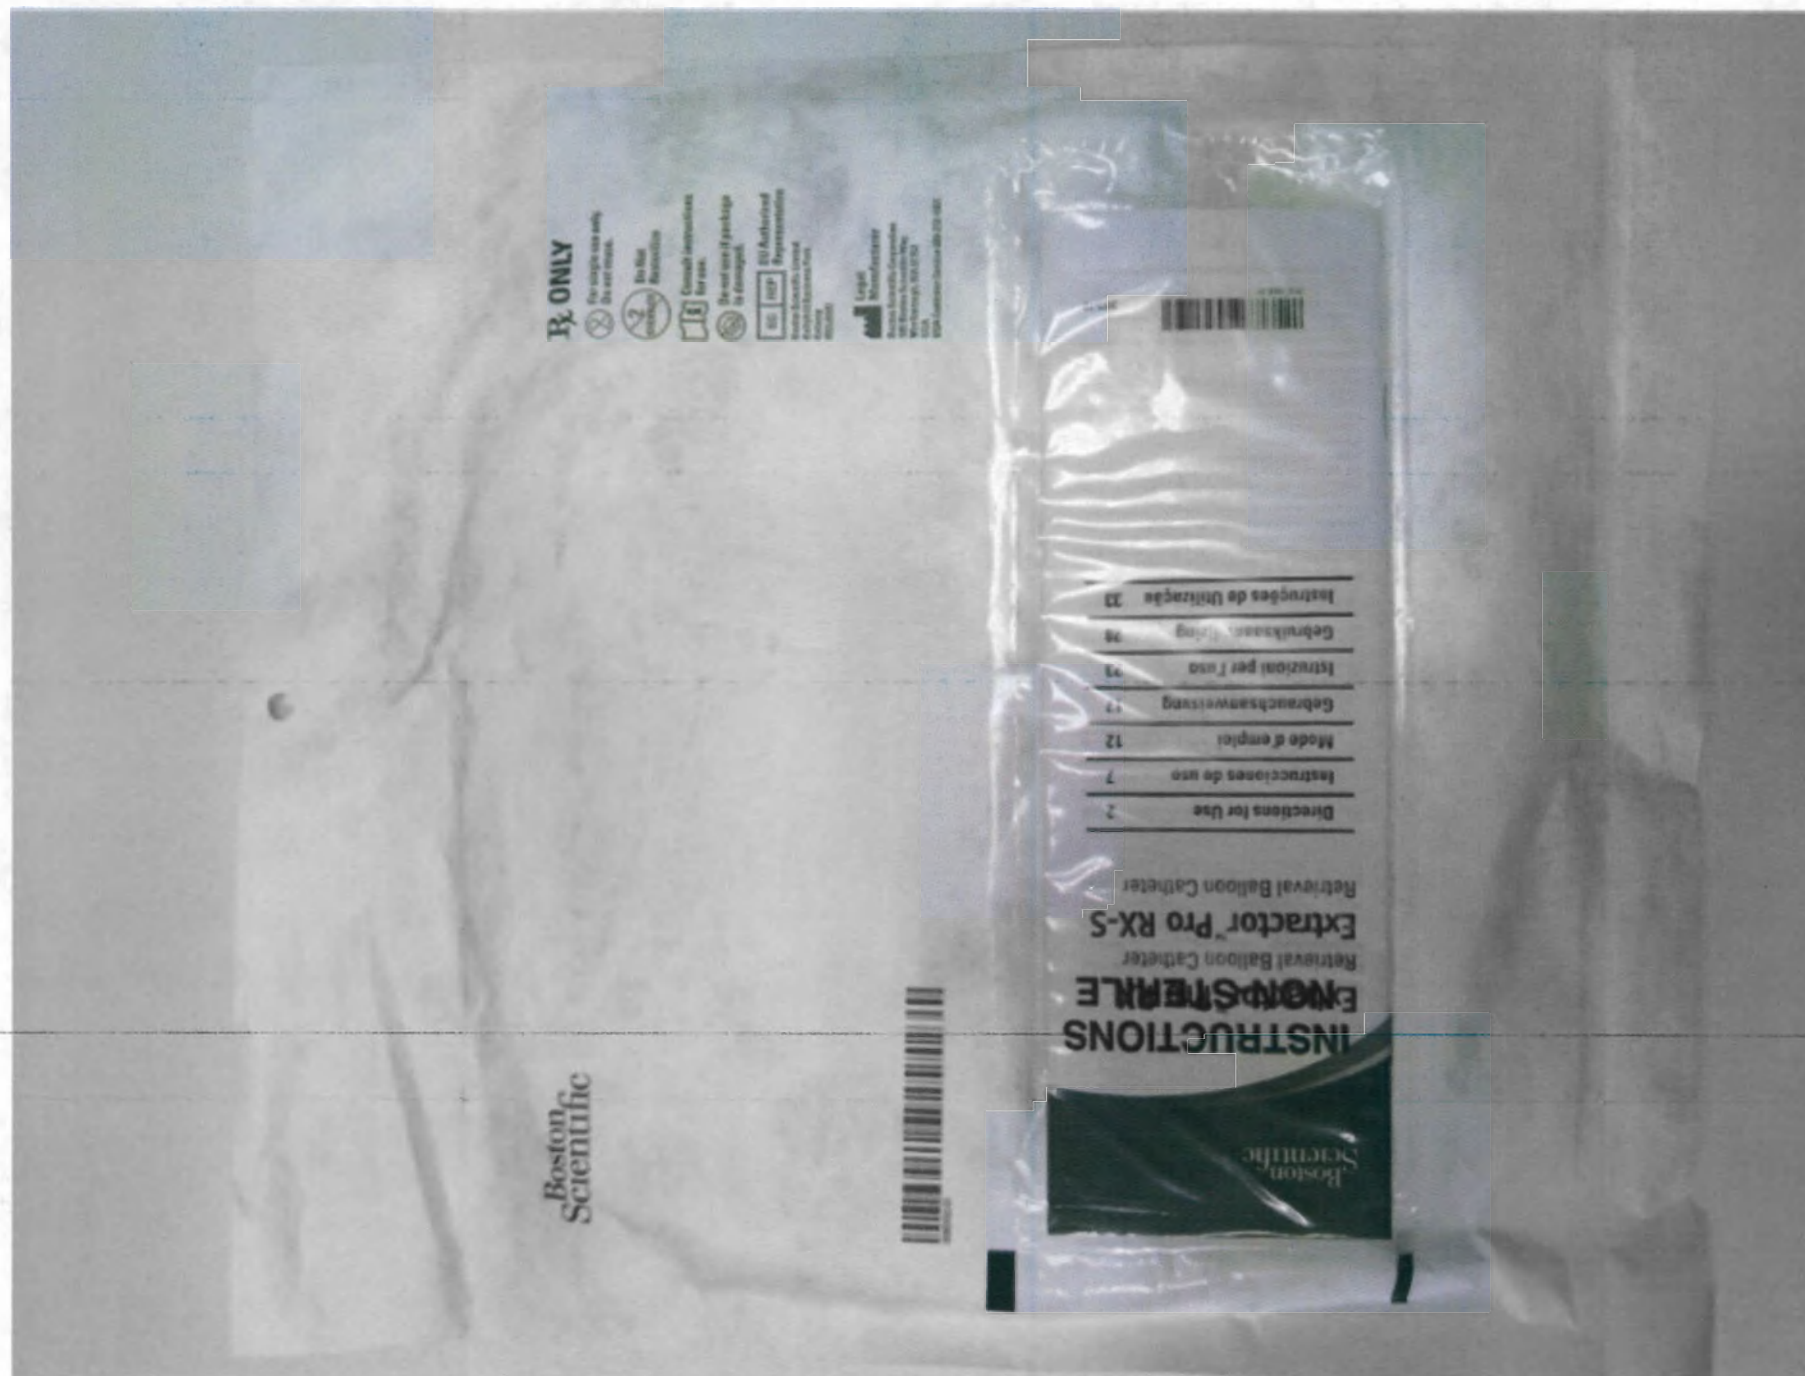


Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX в упаковке (пакете) (вид сзади)

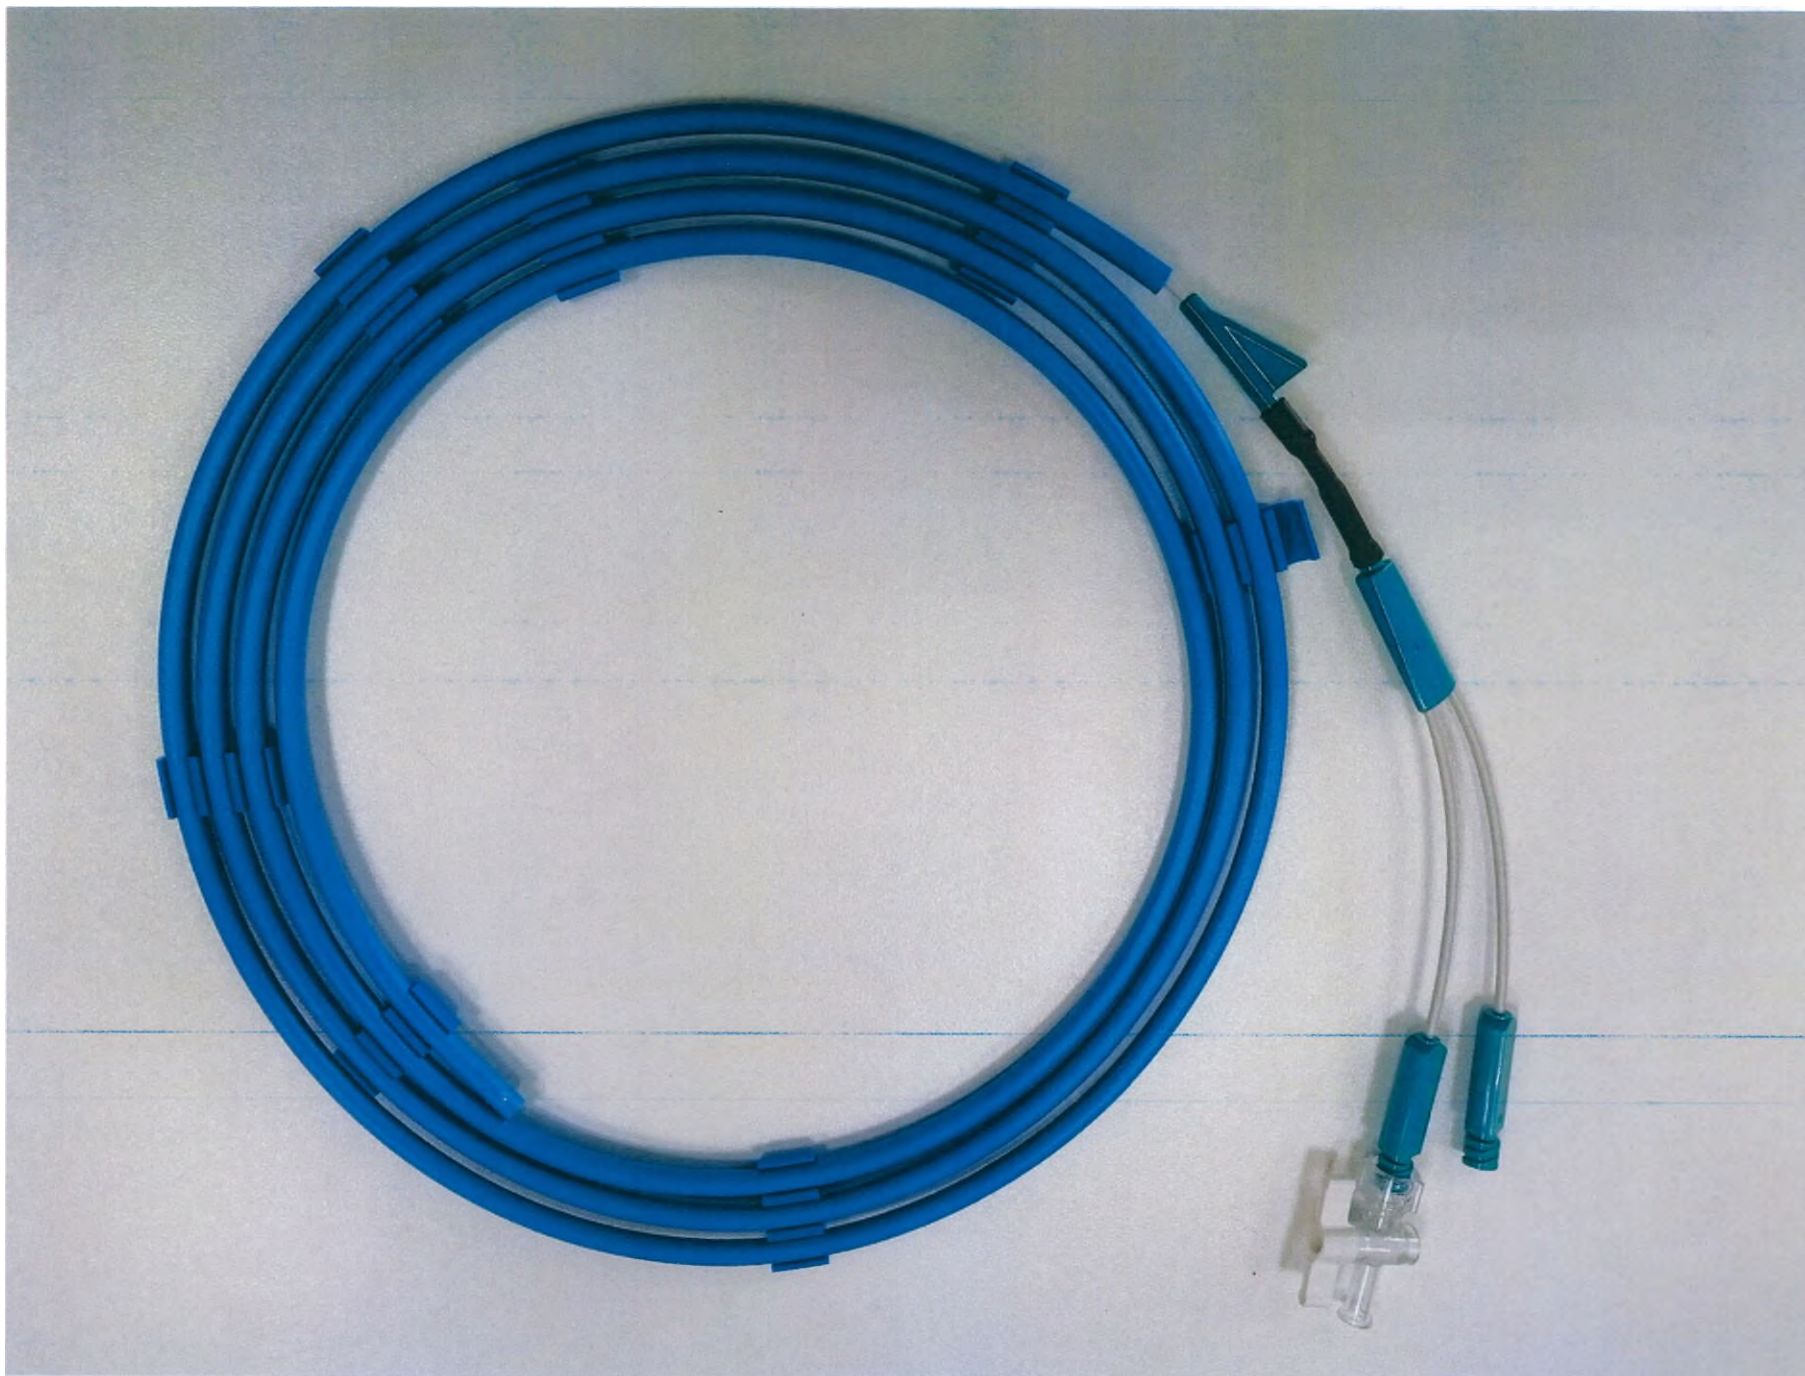


Общий вид катетера баллонного для литоэкстракции Extractor Pro RX в защитной трубке с зажимами для крепления защитной трубки

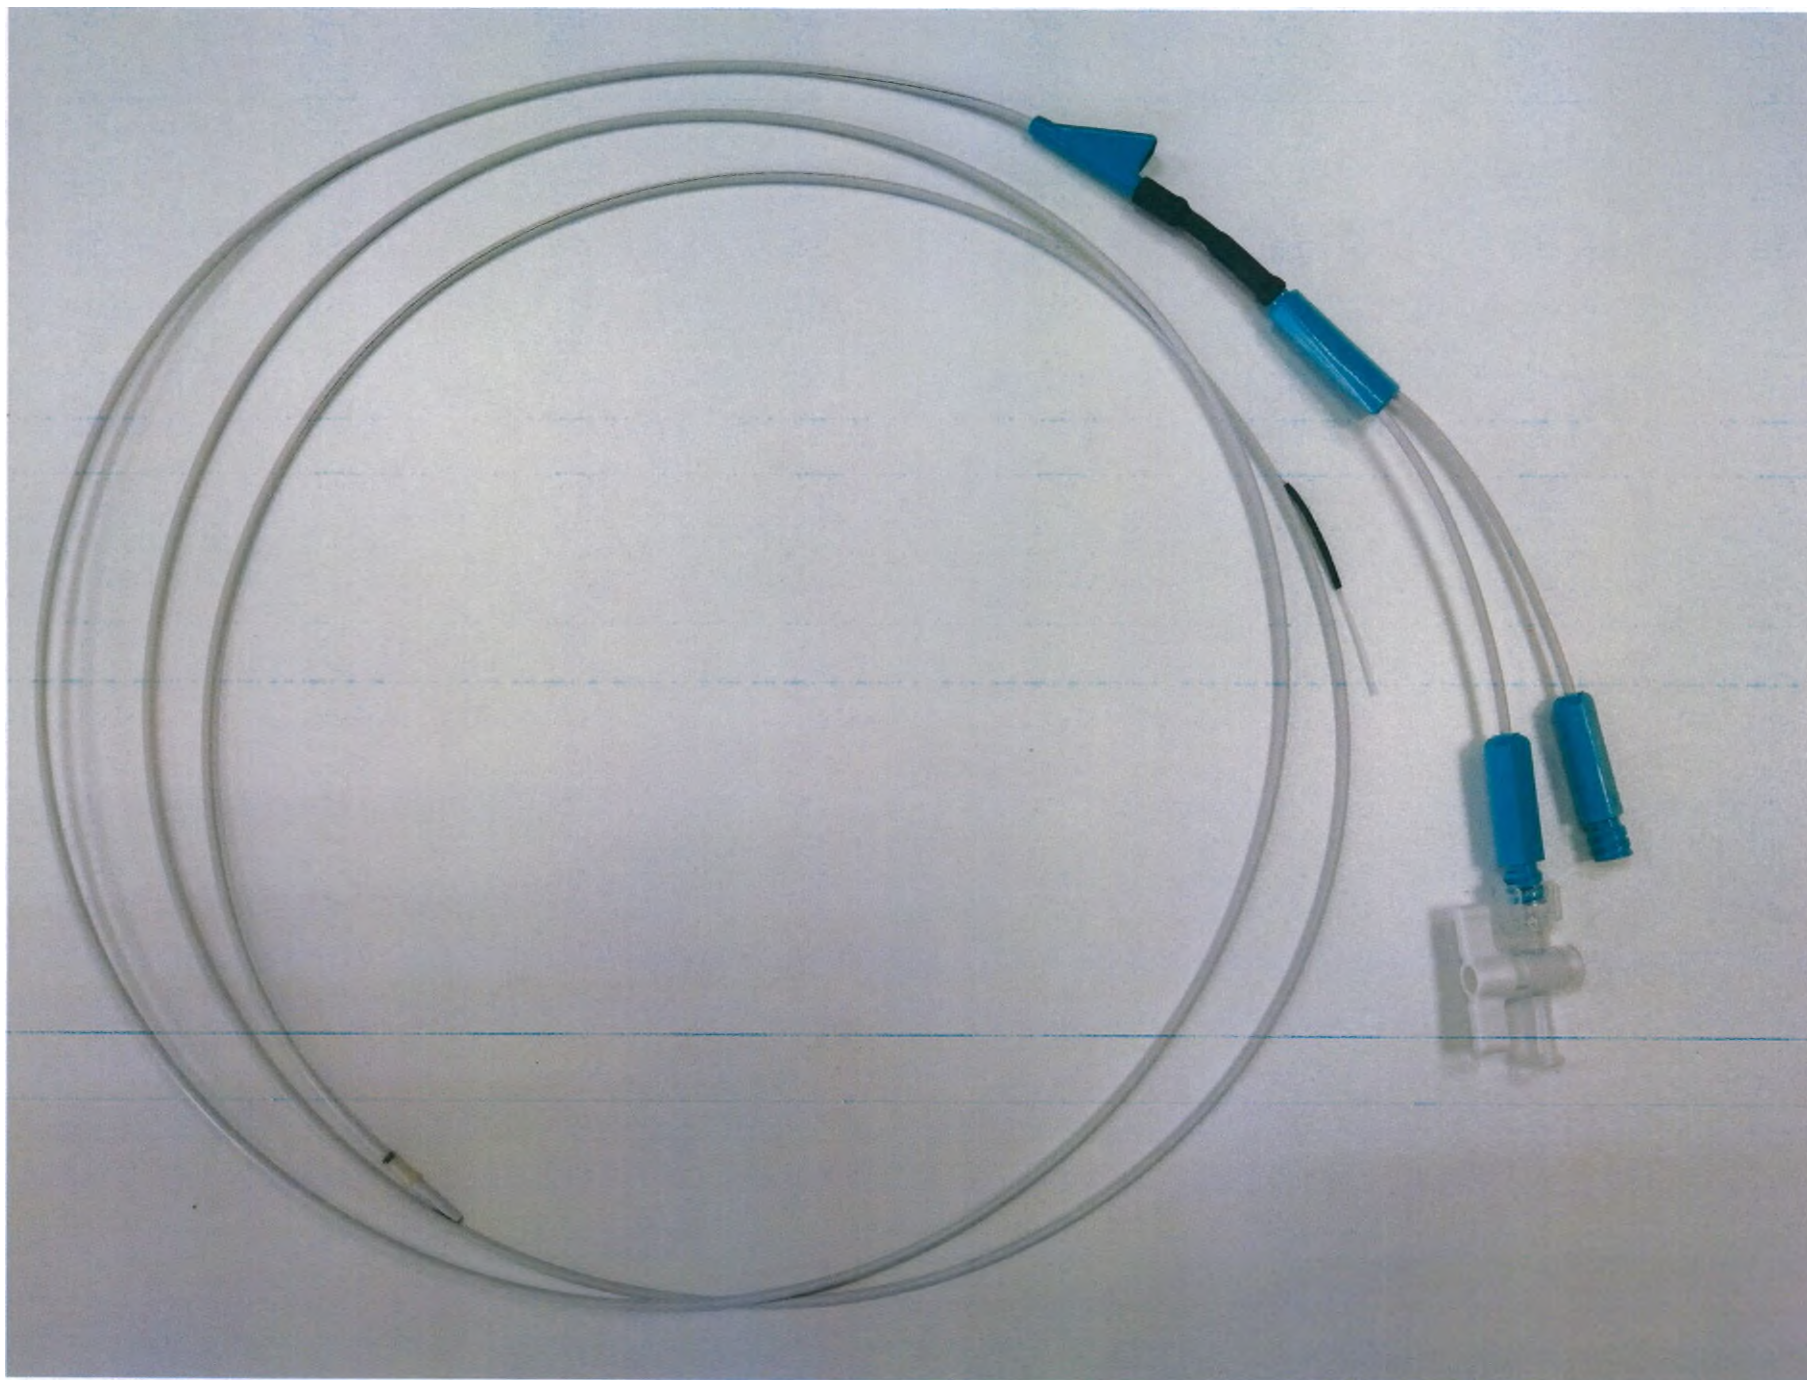


Общий вид катетера баллонного для литоэкстракции Extractor Pro RX

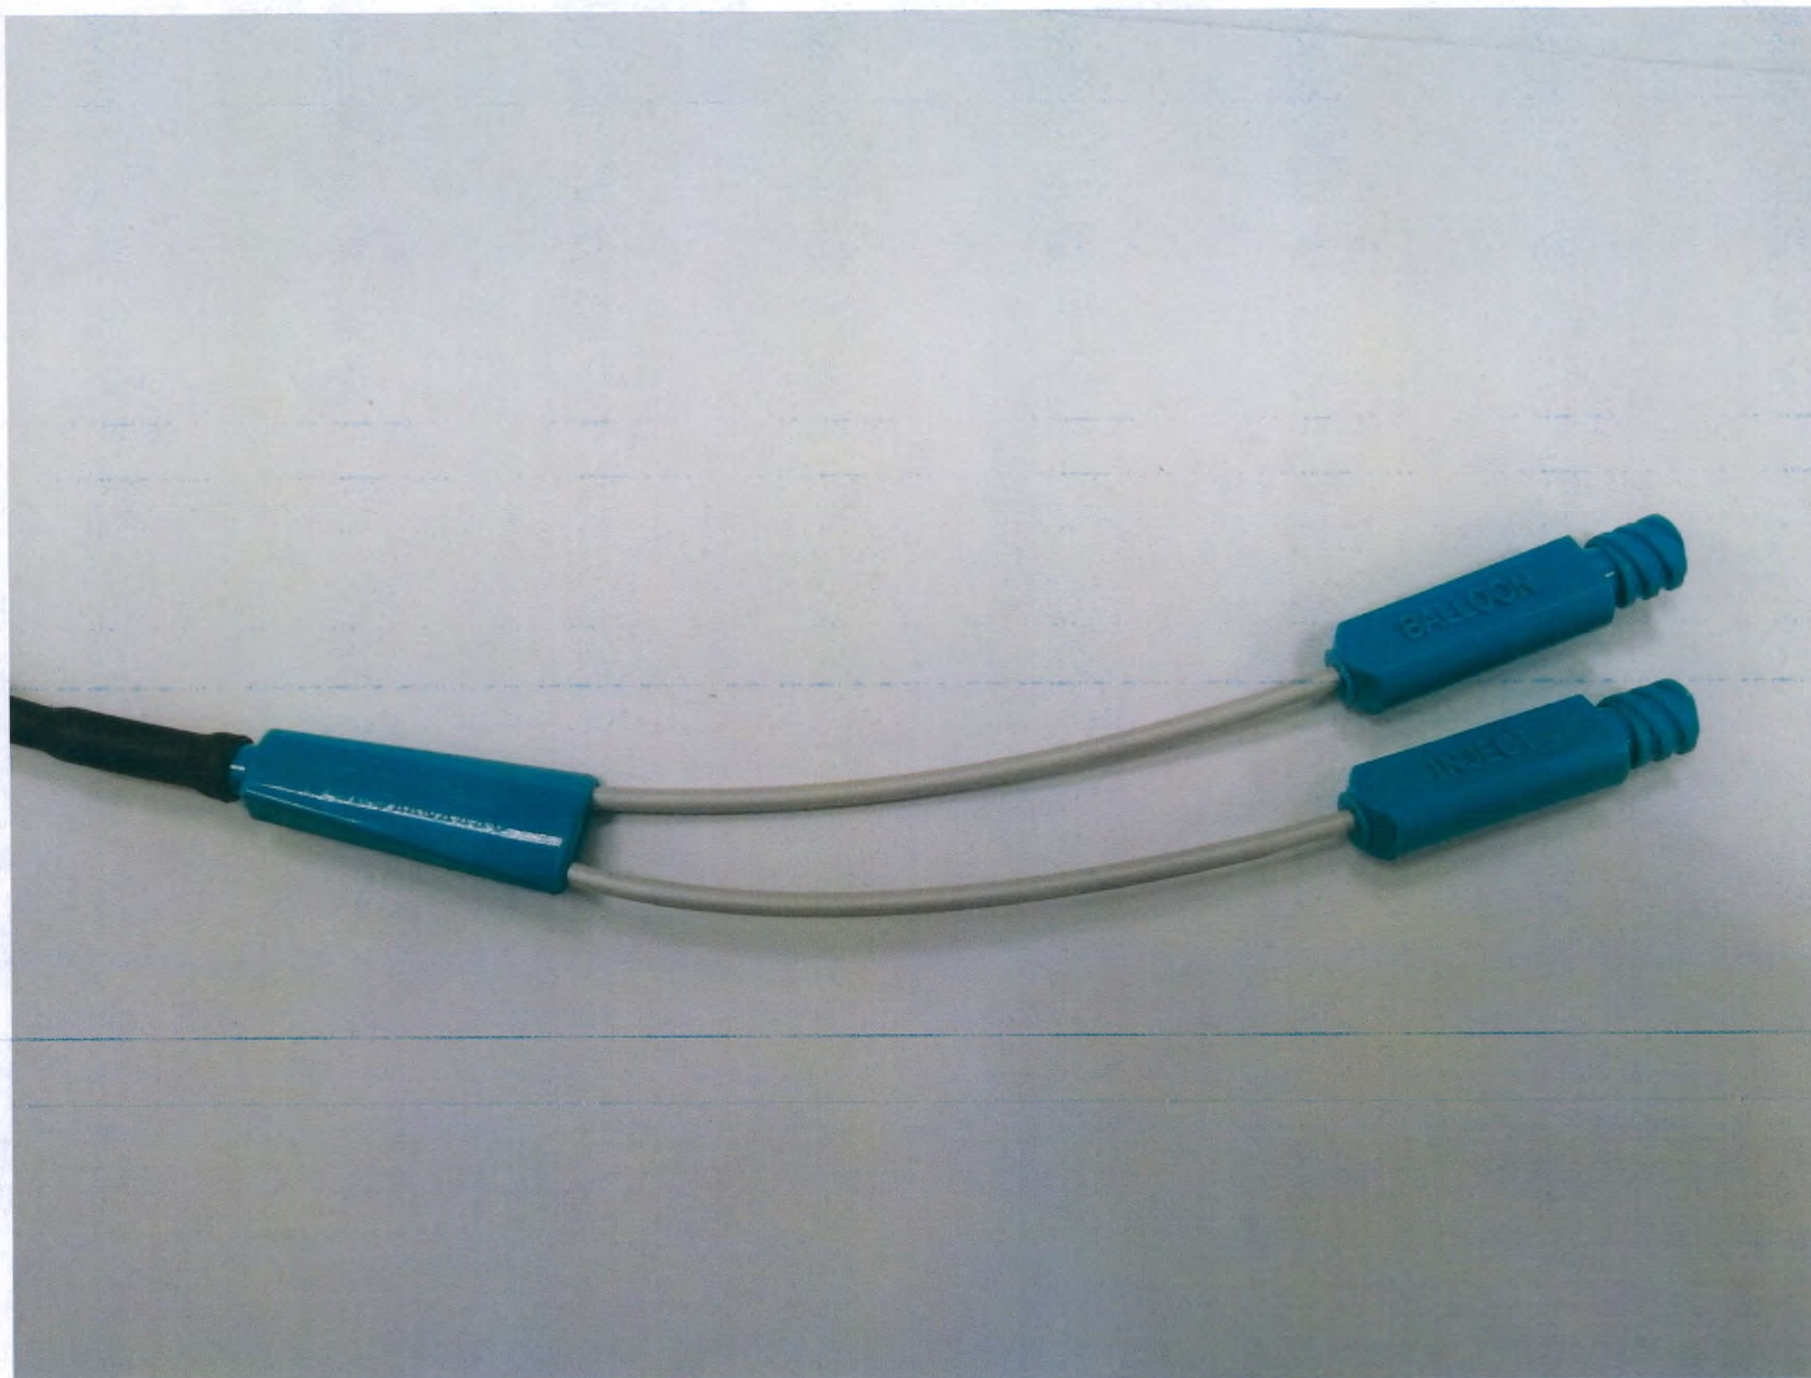


Соединительный узел, трубки и канюли трубок для баллона, инъекции и проводника (вид спереди)

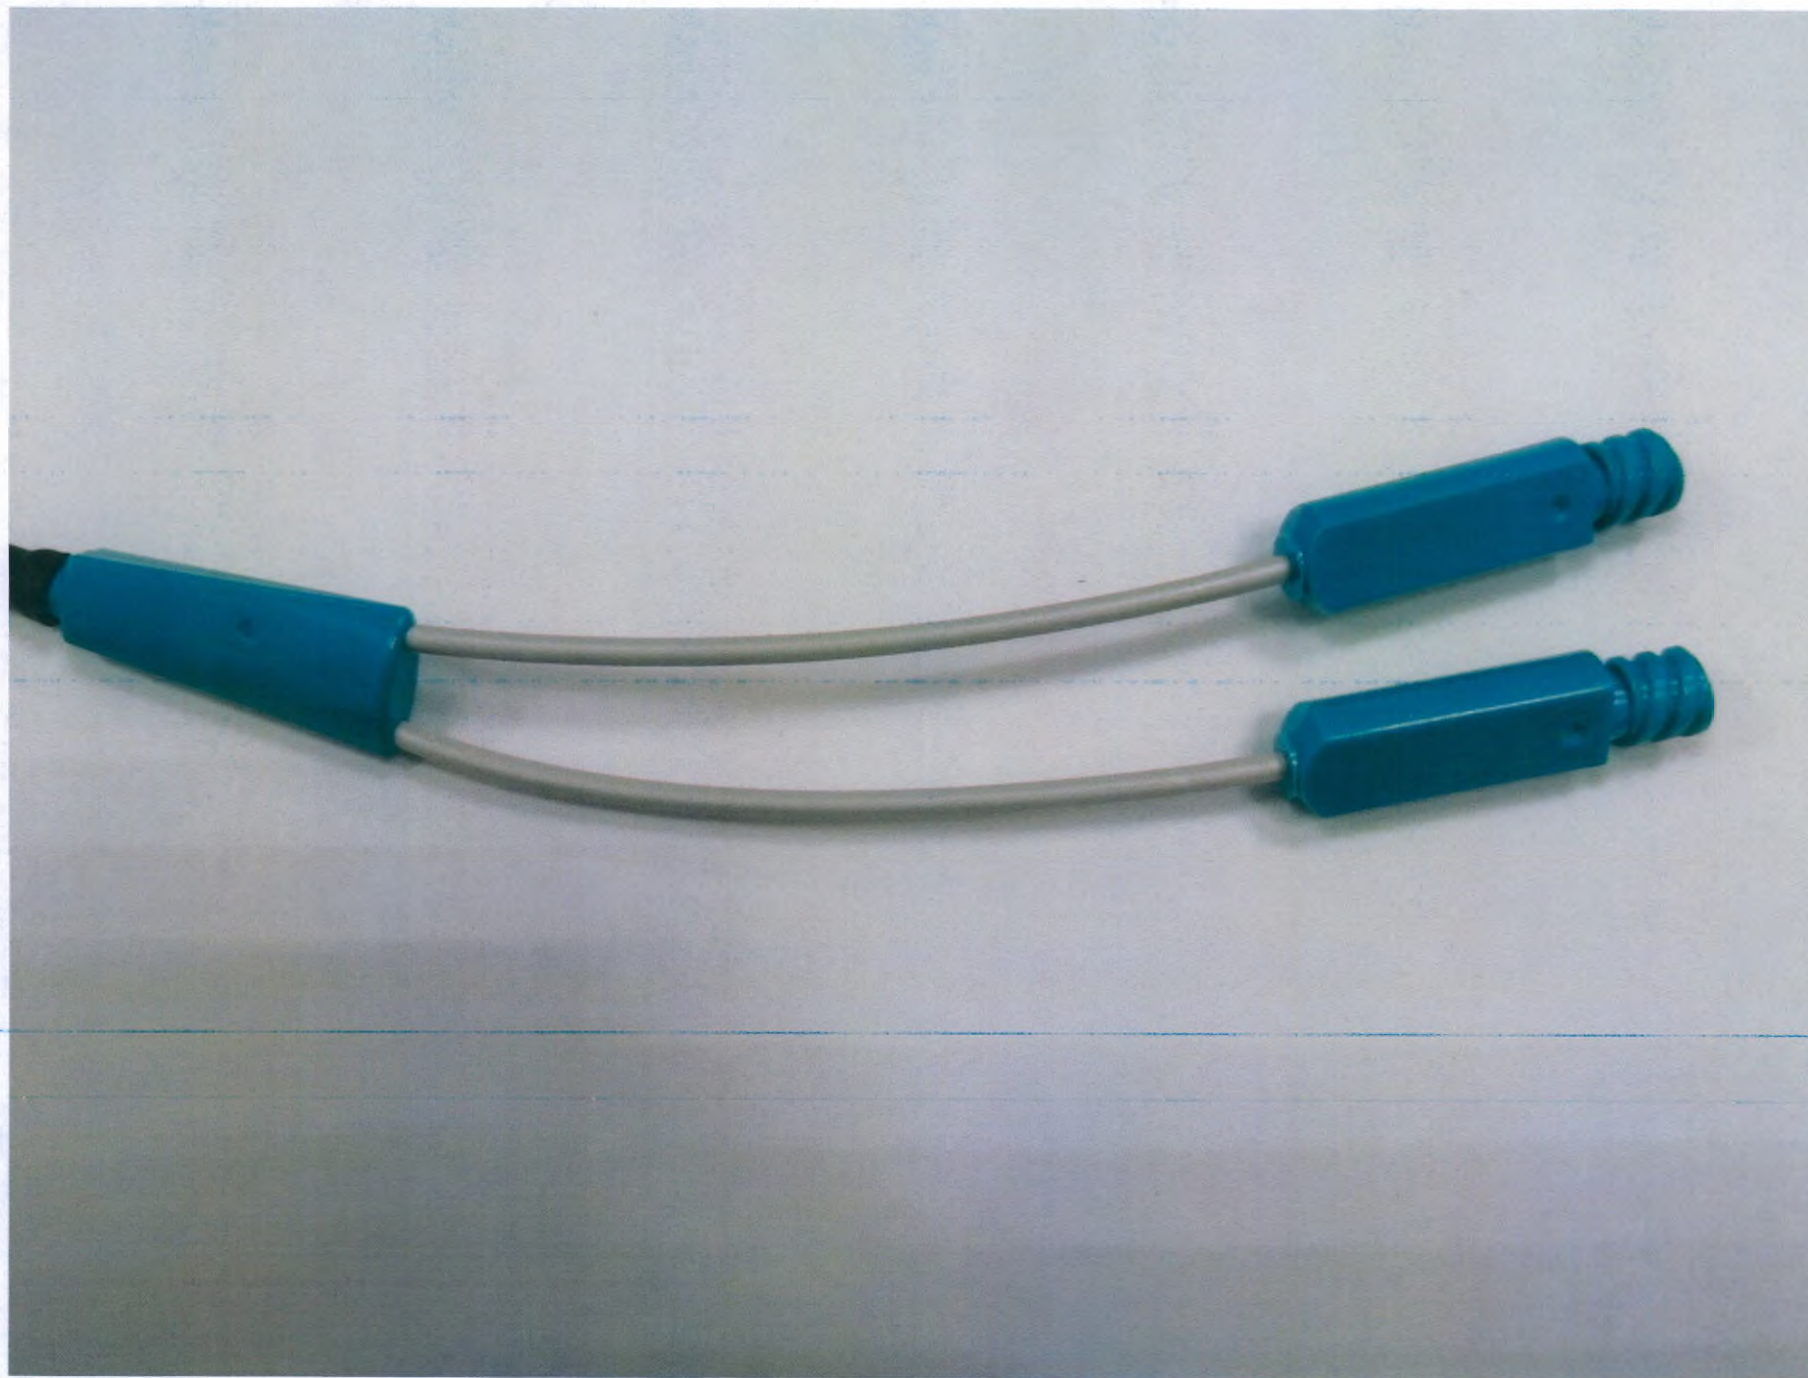


Соединительный узел, трубки и канюли трубок для баллона, инъекции и проводника (вид сзади)

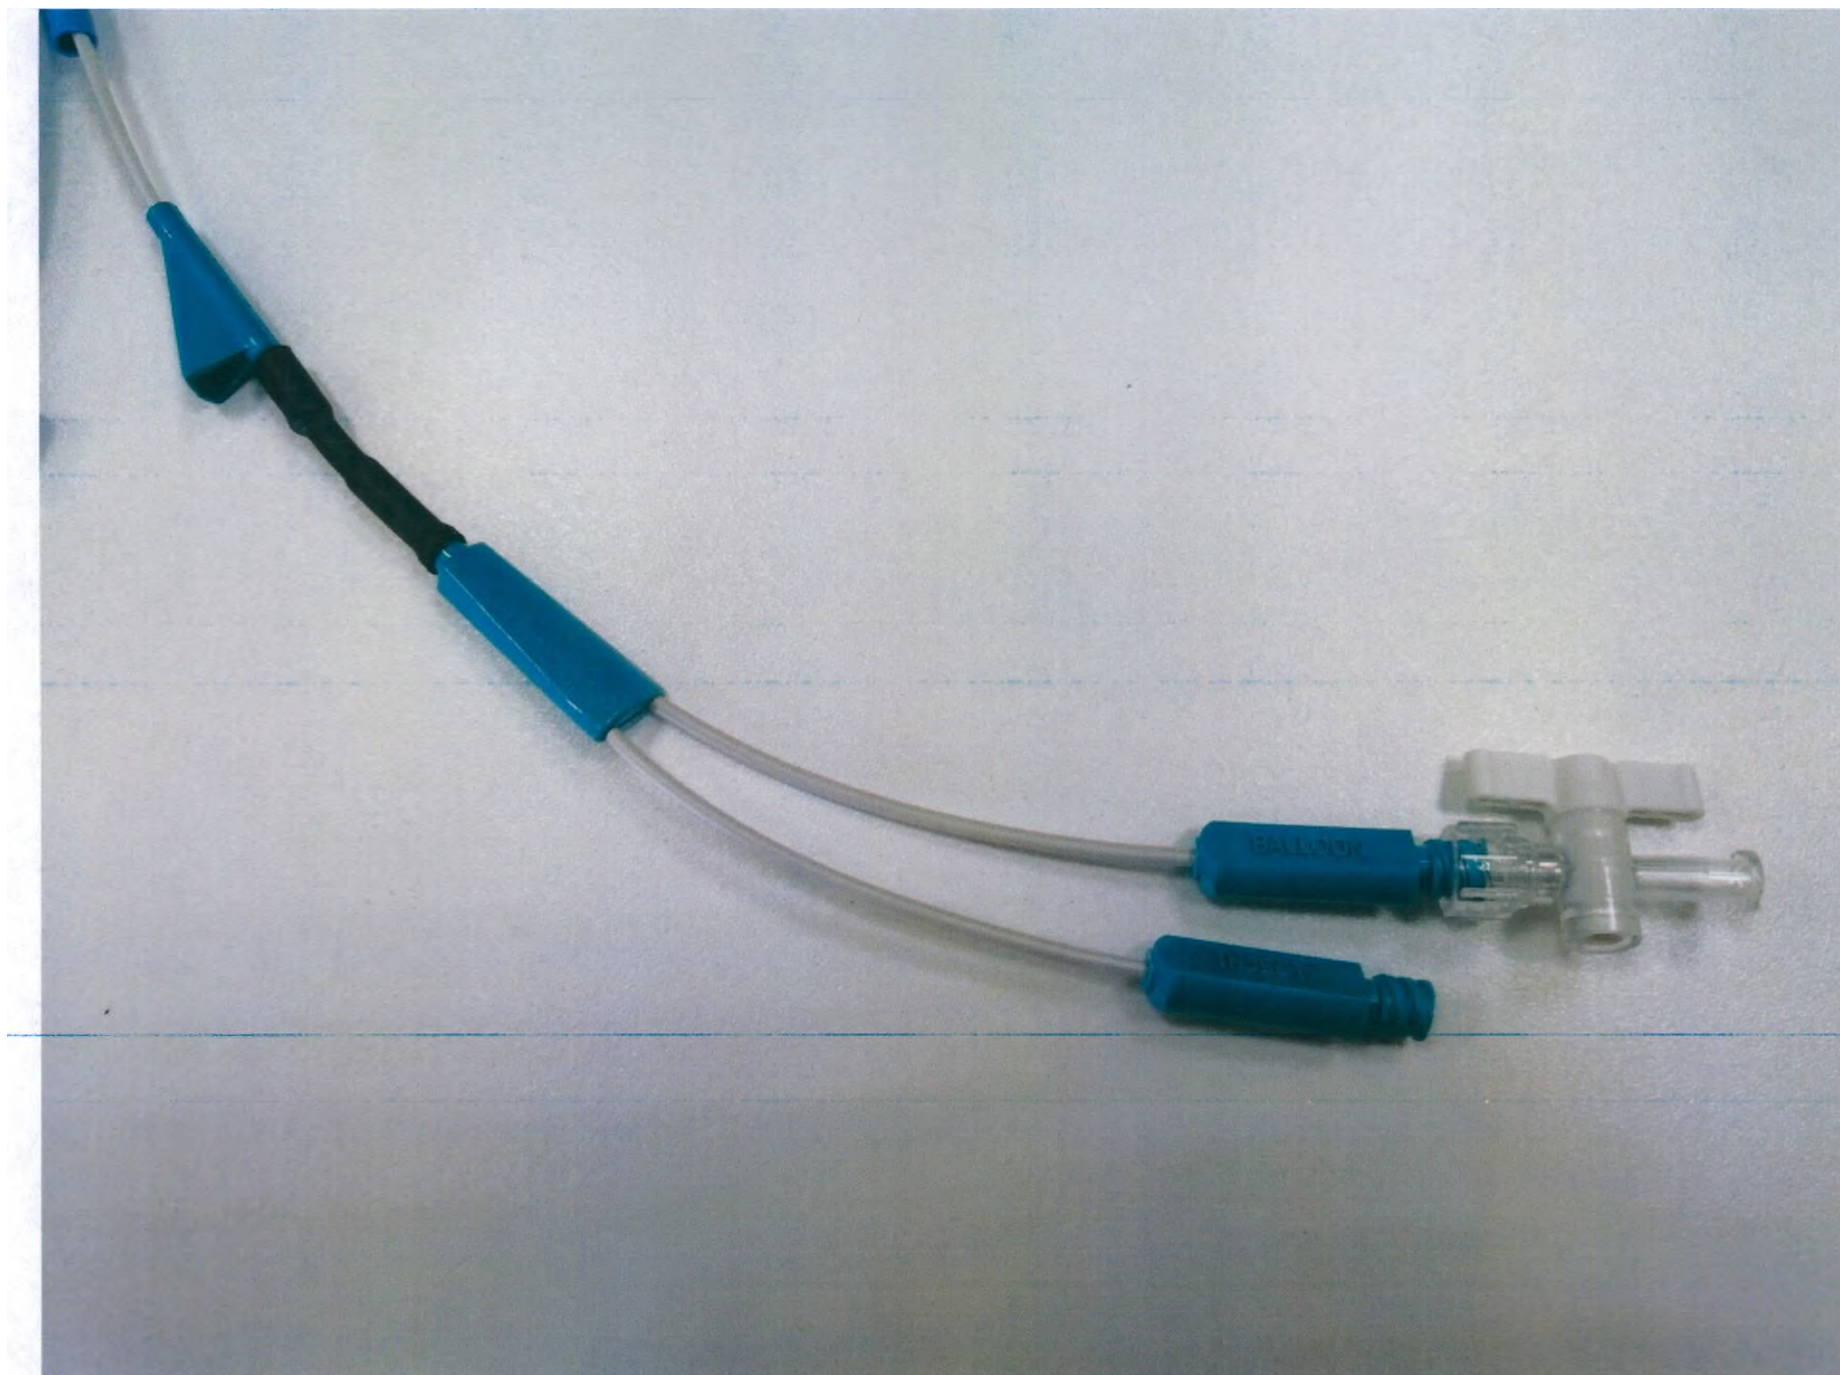


Интродьюсер проводника, соединительный узел, трубки и канюли трубок для баллона и инъекции. На трубке для баллона зафиксирован кран запорный

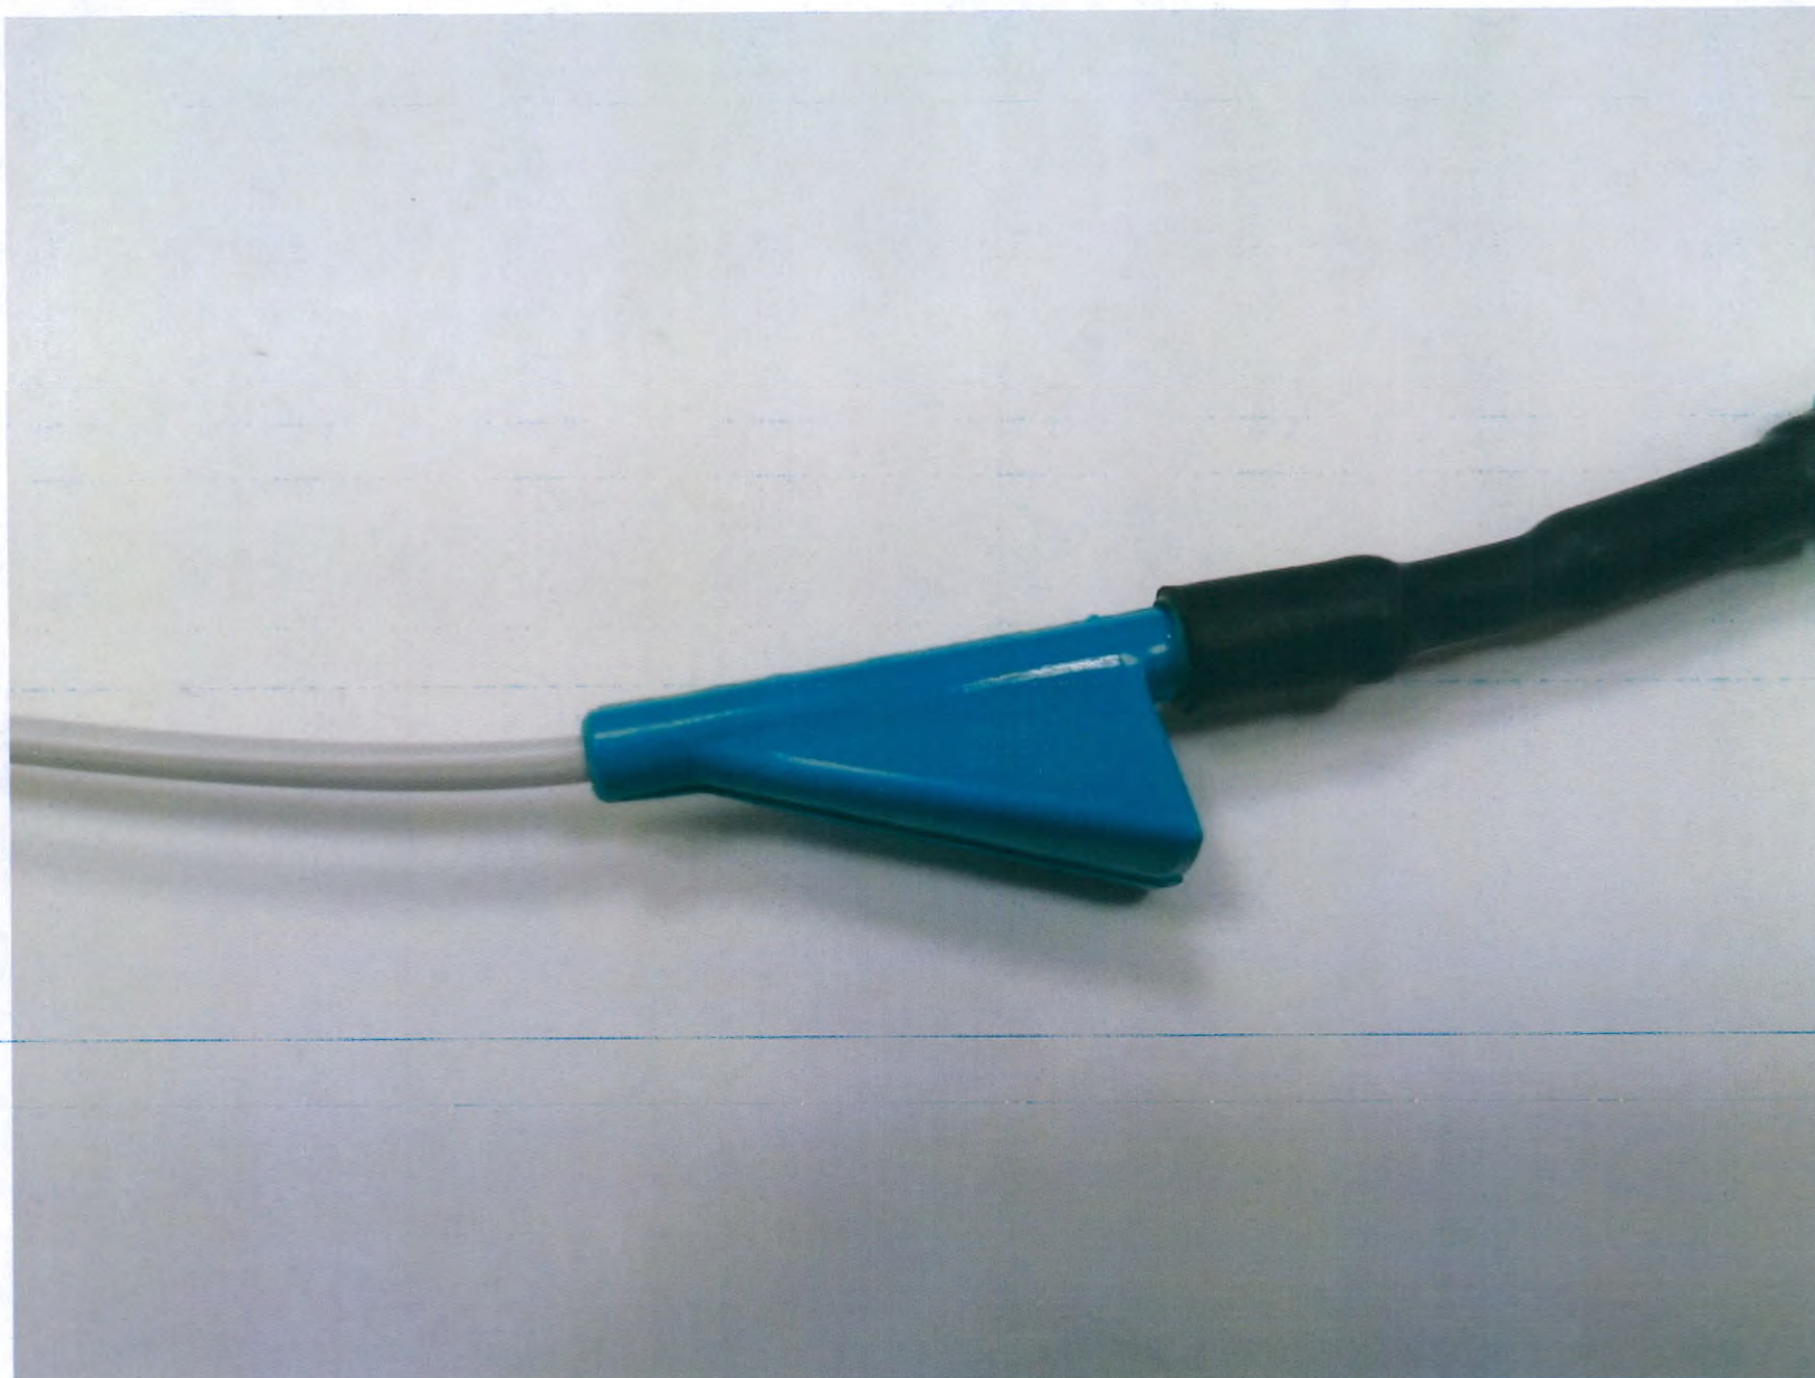


Интродьюсер проводника

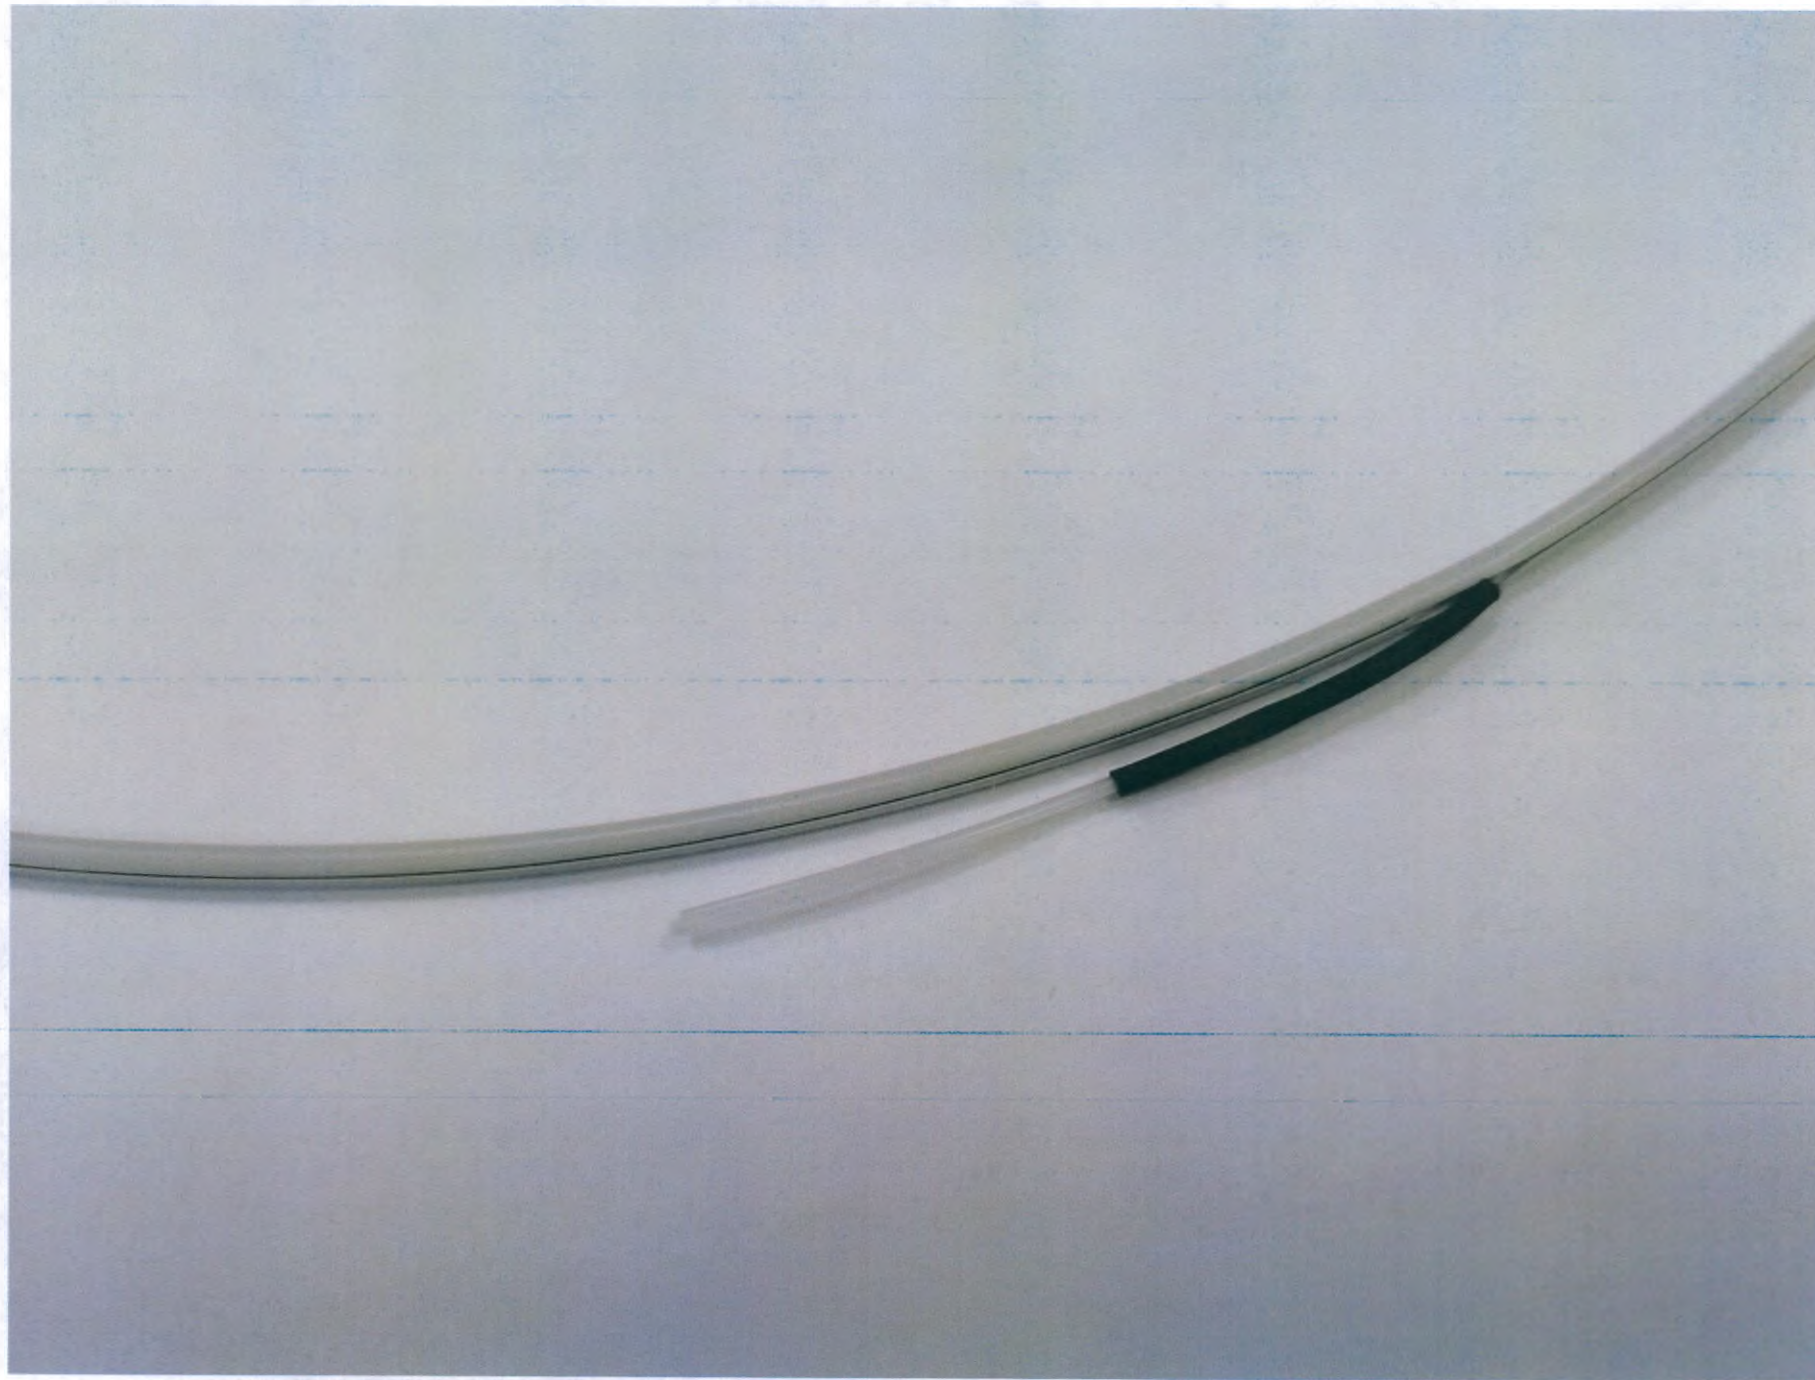

Внешний флажок рампы

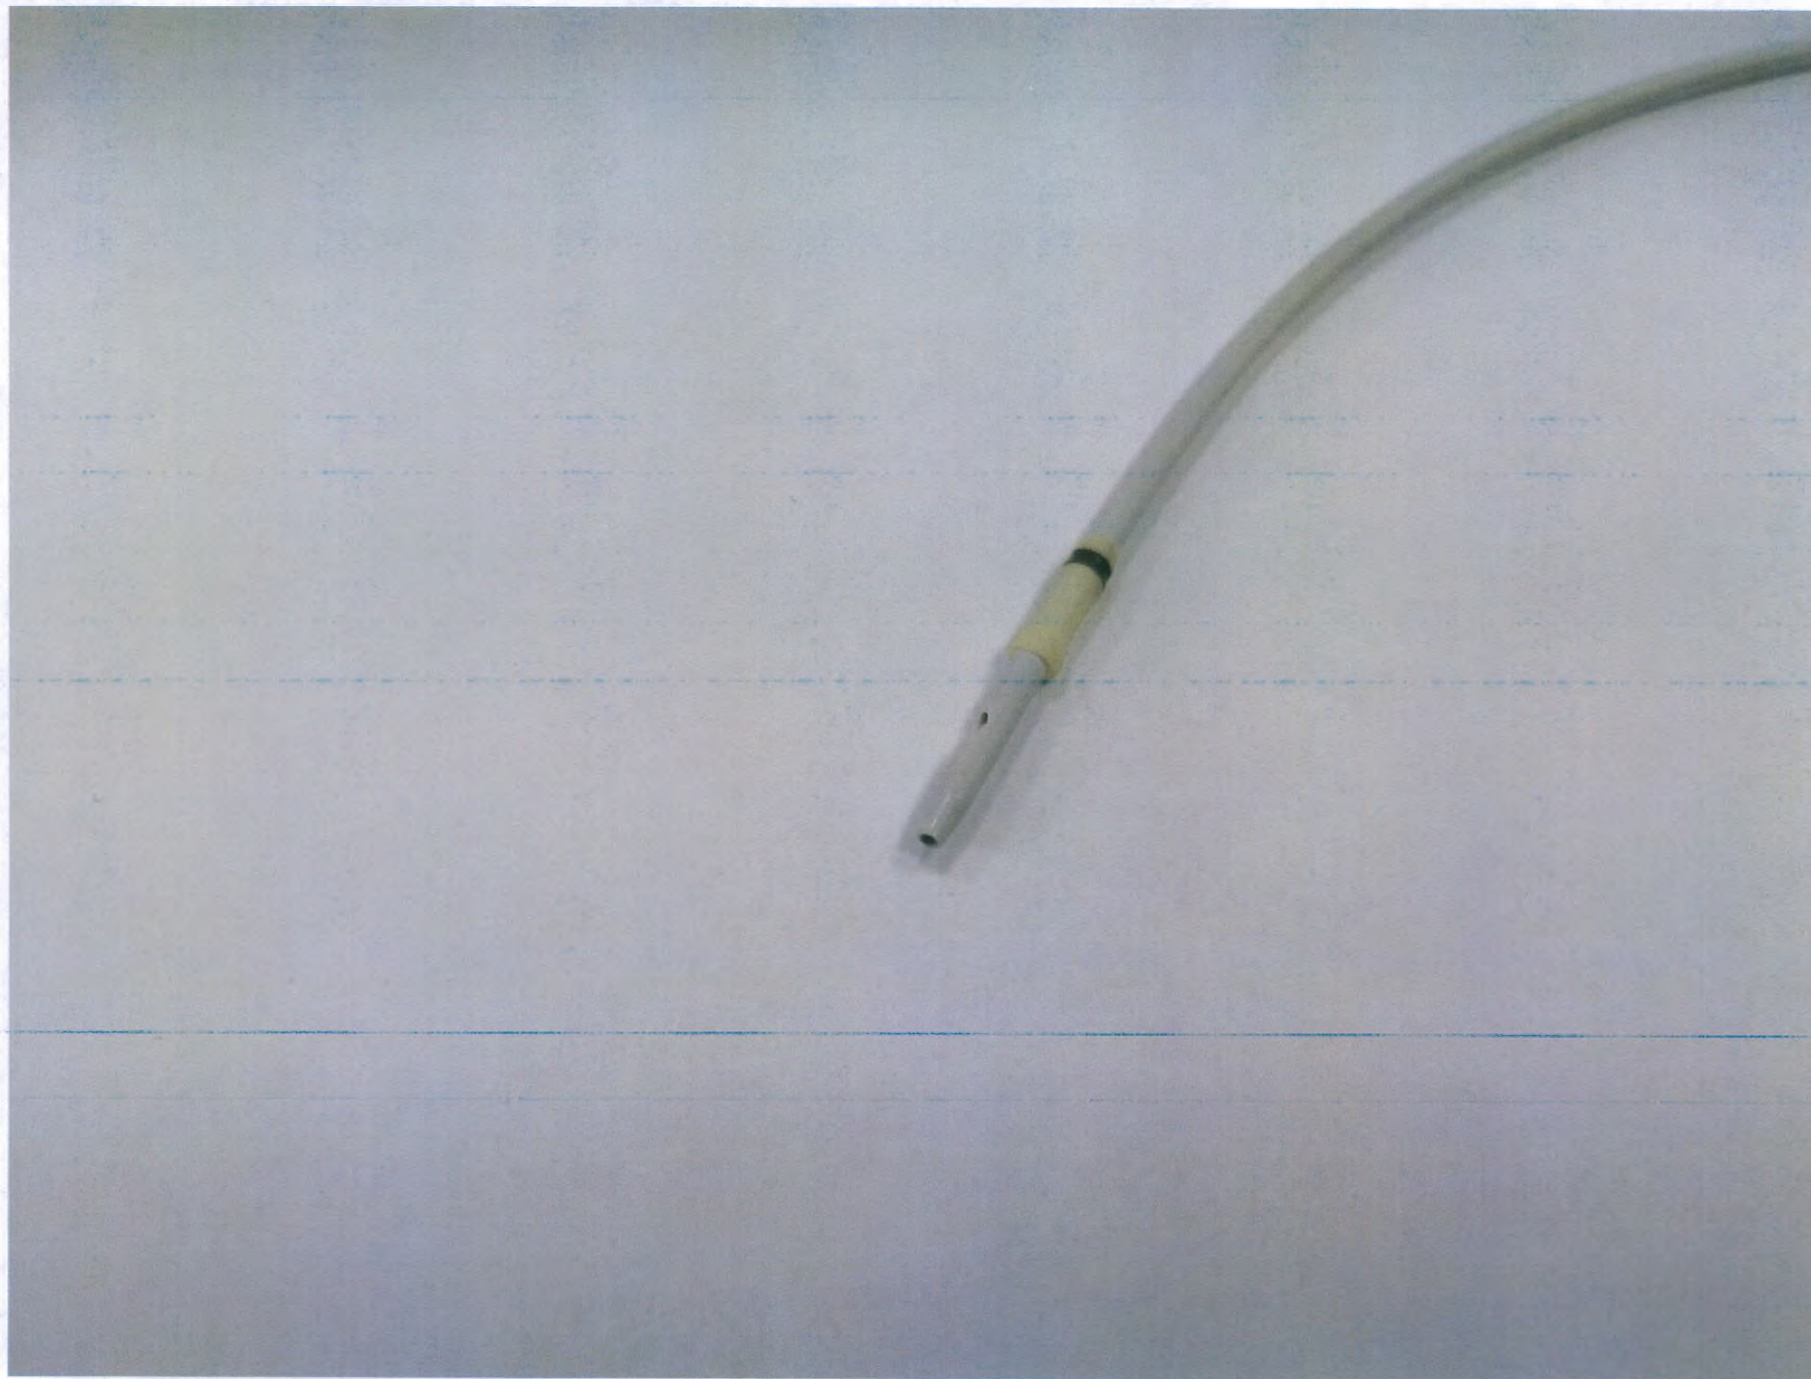

Дистальный конец катетера, баллон (9 мм/12 мм), рентгеноконтрастный маркер, порт для инъекции (выше баллона)

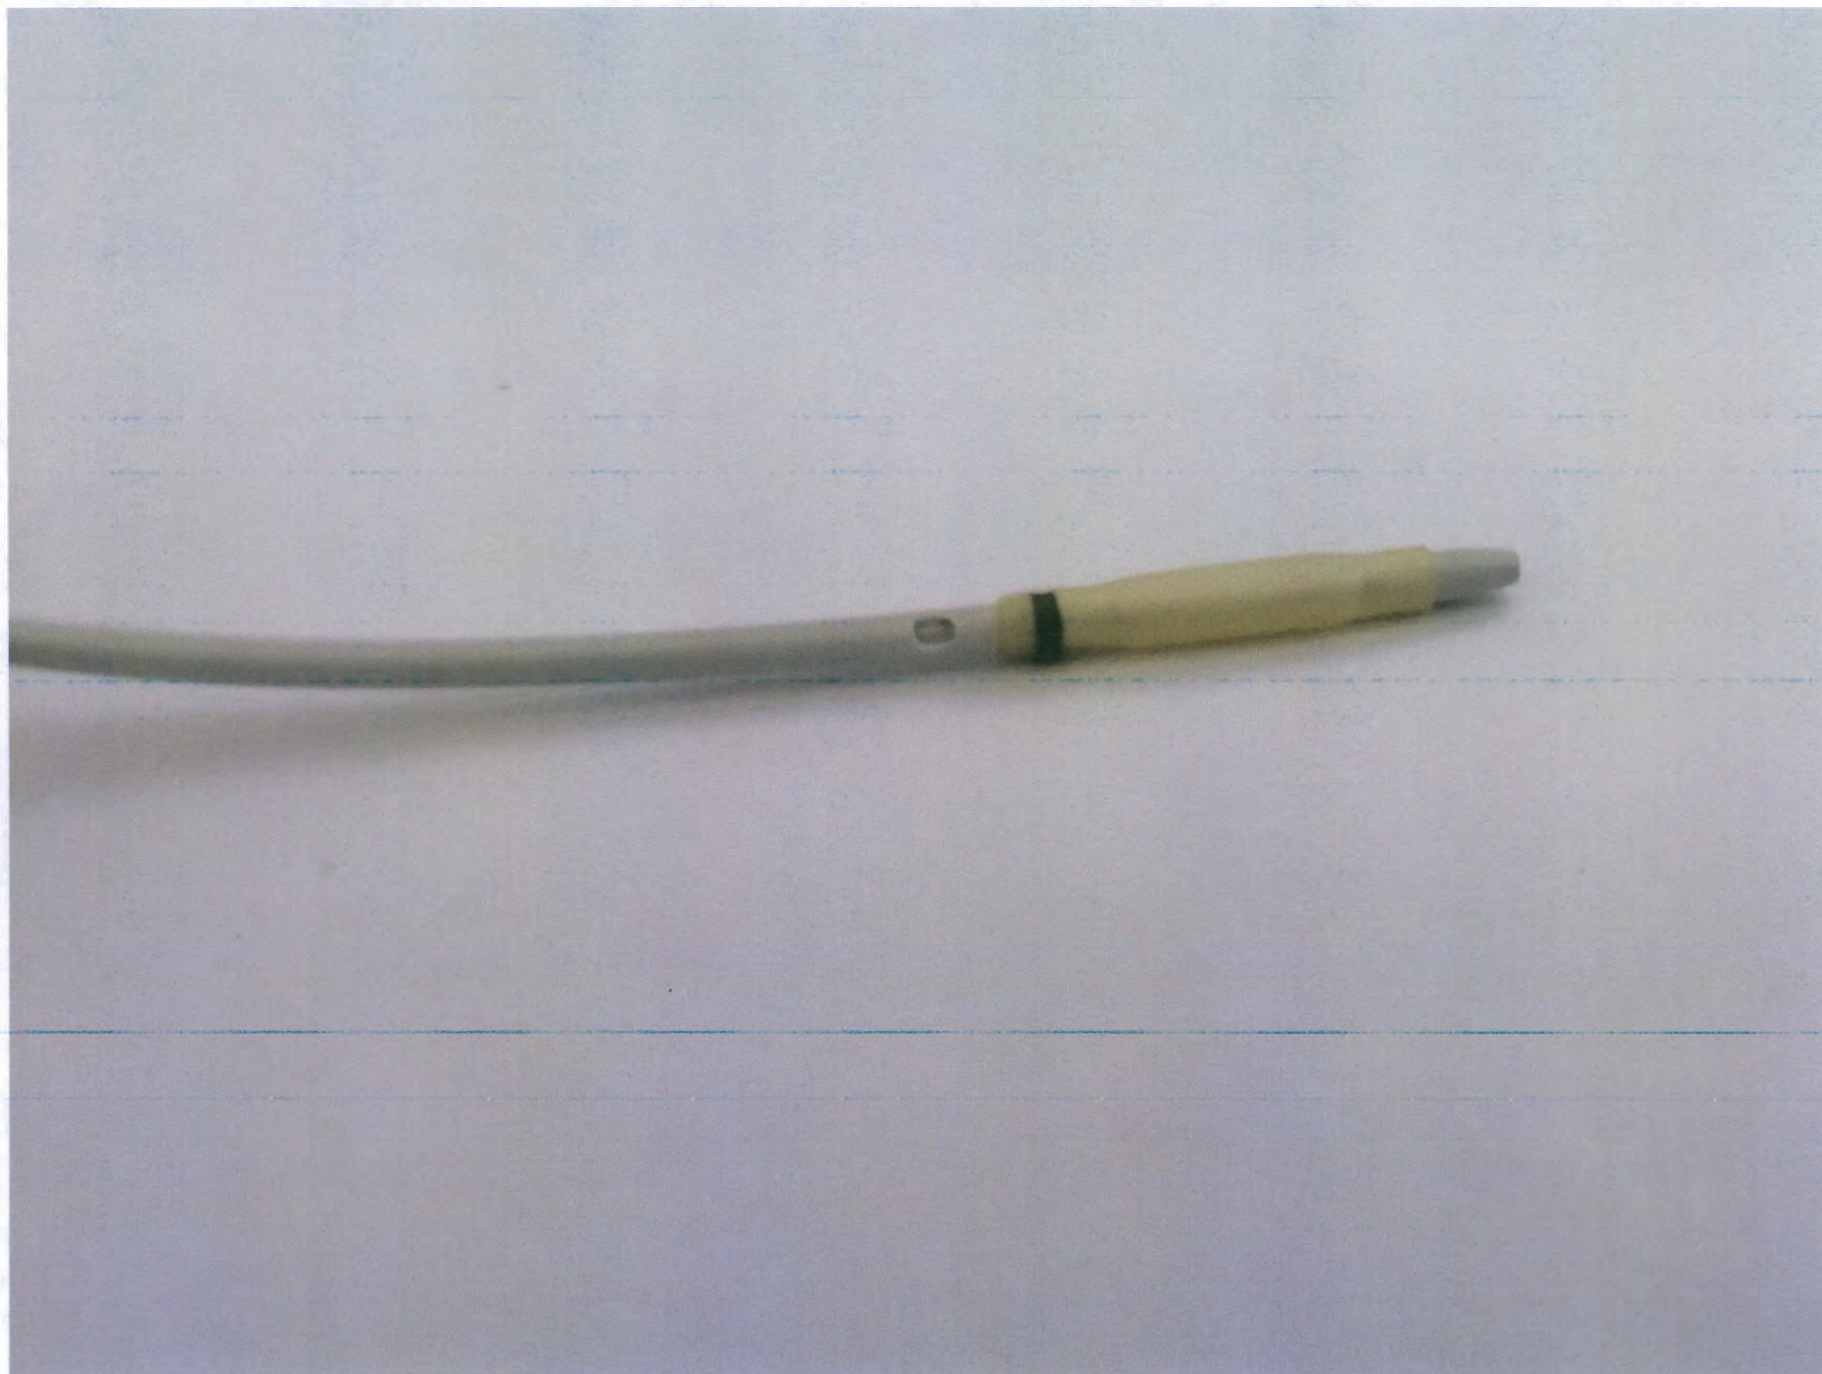

Дистальный конец катетера, баллон (15 мм/18 мм), рентгеноконтрастный маркер, порт для инъекции (ниже баллона)

Boston
Scientific

Extractor™ Pro RX

Retrieval Balloon Catheter

Extractor™ Pro RX-S

Retrieval Balloon Catheter

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	7
Mode d'emploi	12
Gebrauchsanweisung	17
Istruzioni per l'uso	23
Gebruiksaanwijzing	28
Instruções de Utilização	33



91070968-01

2015-12

Инструкция по применению (вид спереди)

**ARG Argentina
Local Contact**

Para obtener información de
contacto de Boston Scientific
Argentina SA, por favor, acceda al
link www.bostonscientific.com/arg

**BRA Brazil
Local Contact**

Para informações de contato da
Boston Scientific do Brasil Ltda,
por favor, acesse o link
www.bostonscientific.com/brs

**EC REP EU Authorized
Representative**

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

**AUS Australian
Sponsor Address**

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

**Legal
Manufacturer**

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001



Do not use if package
is damaged.



Recyclable
Package


CE 0344

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.


Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro XL, в вариантах исполнения




Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro XL в упаковке (пакете) (вид спереди)

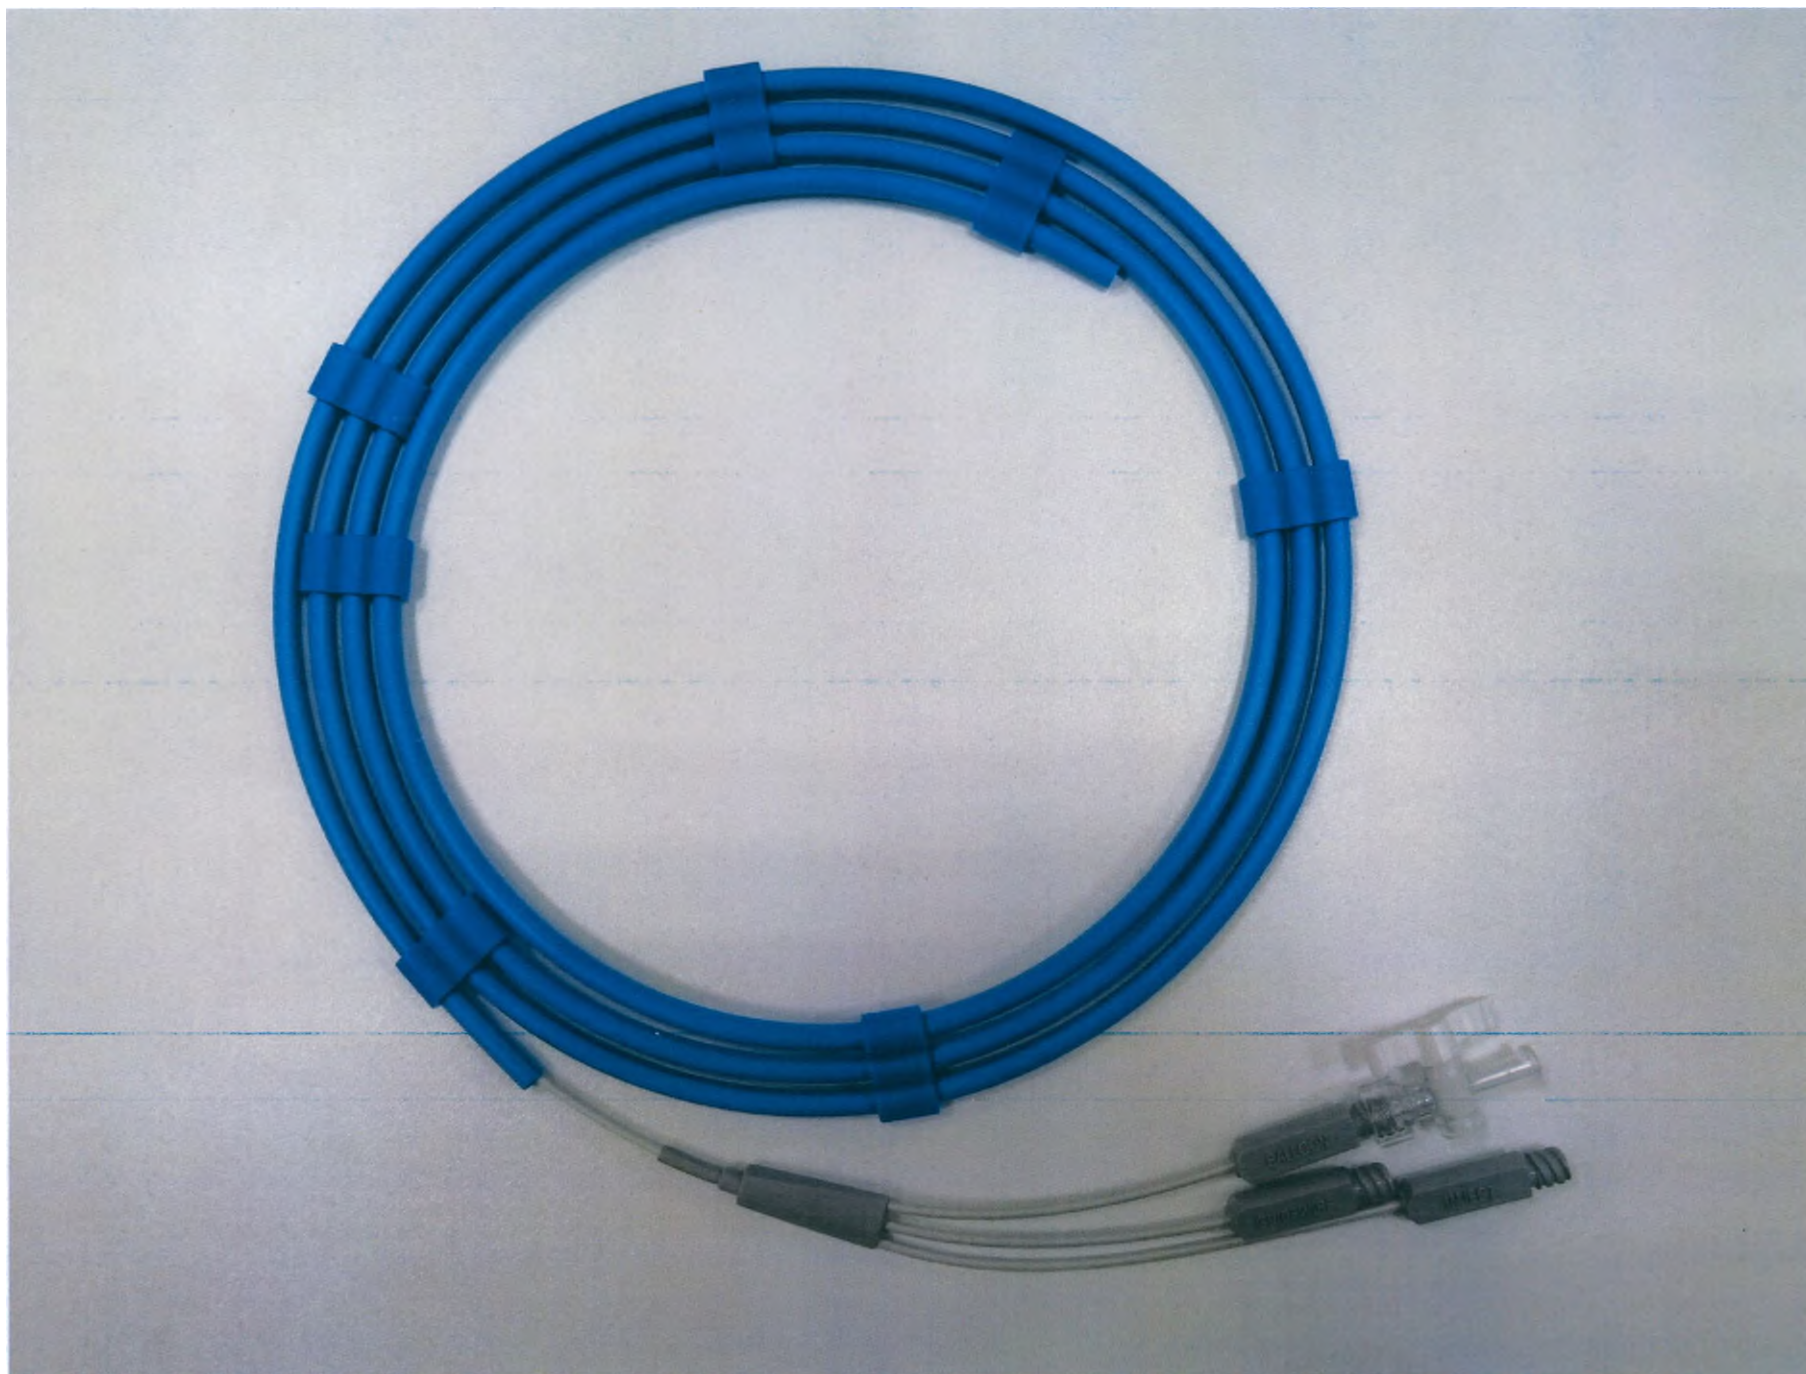


Общий вид катетера баллонного для литоэкстракции Extractor Pro XL в защитной трубке с зажимами для крепления защитной трубки

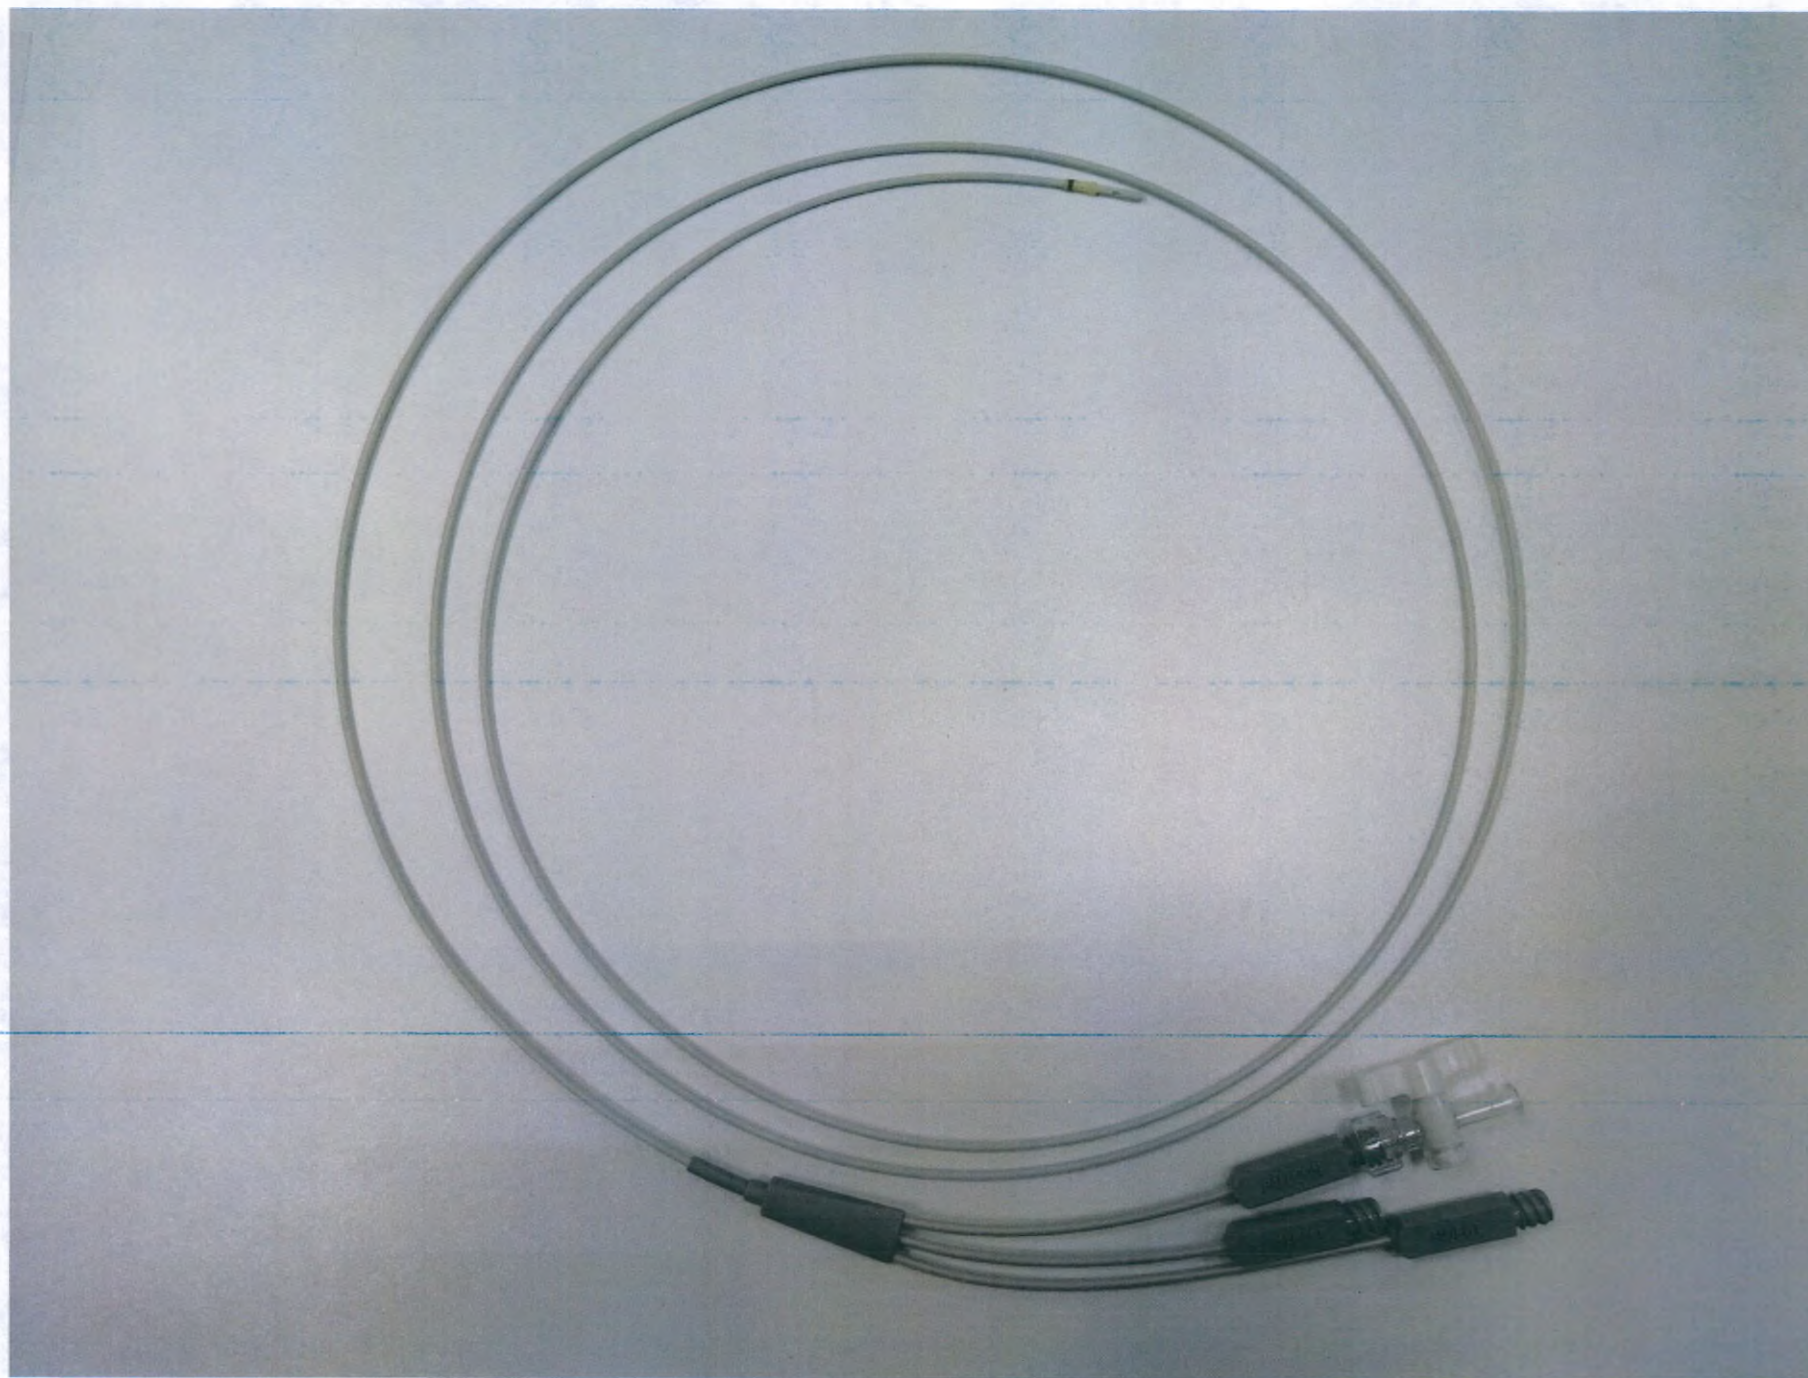


Общий вид катетера баллонного для литоэкстракции Extractor Pro XL

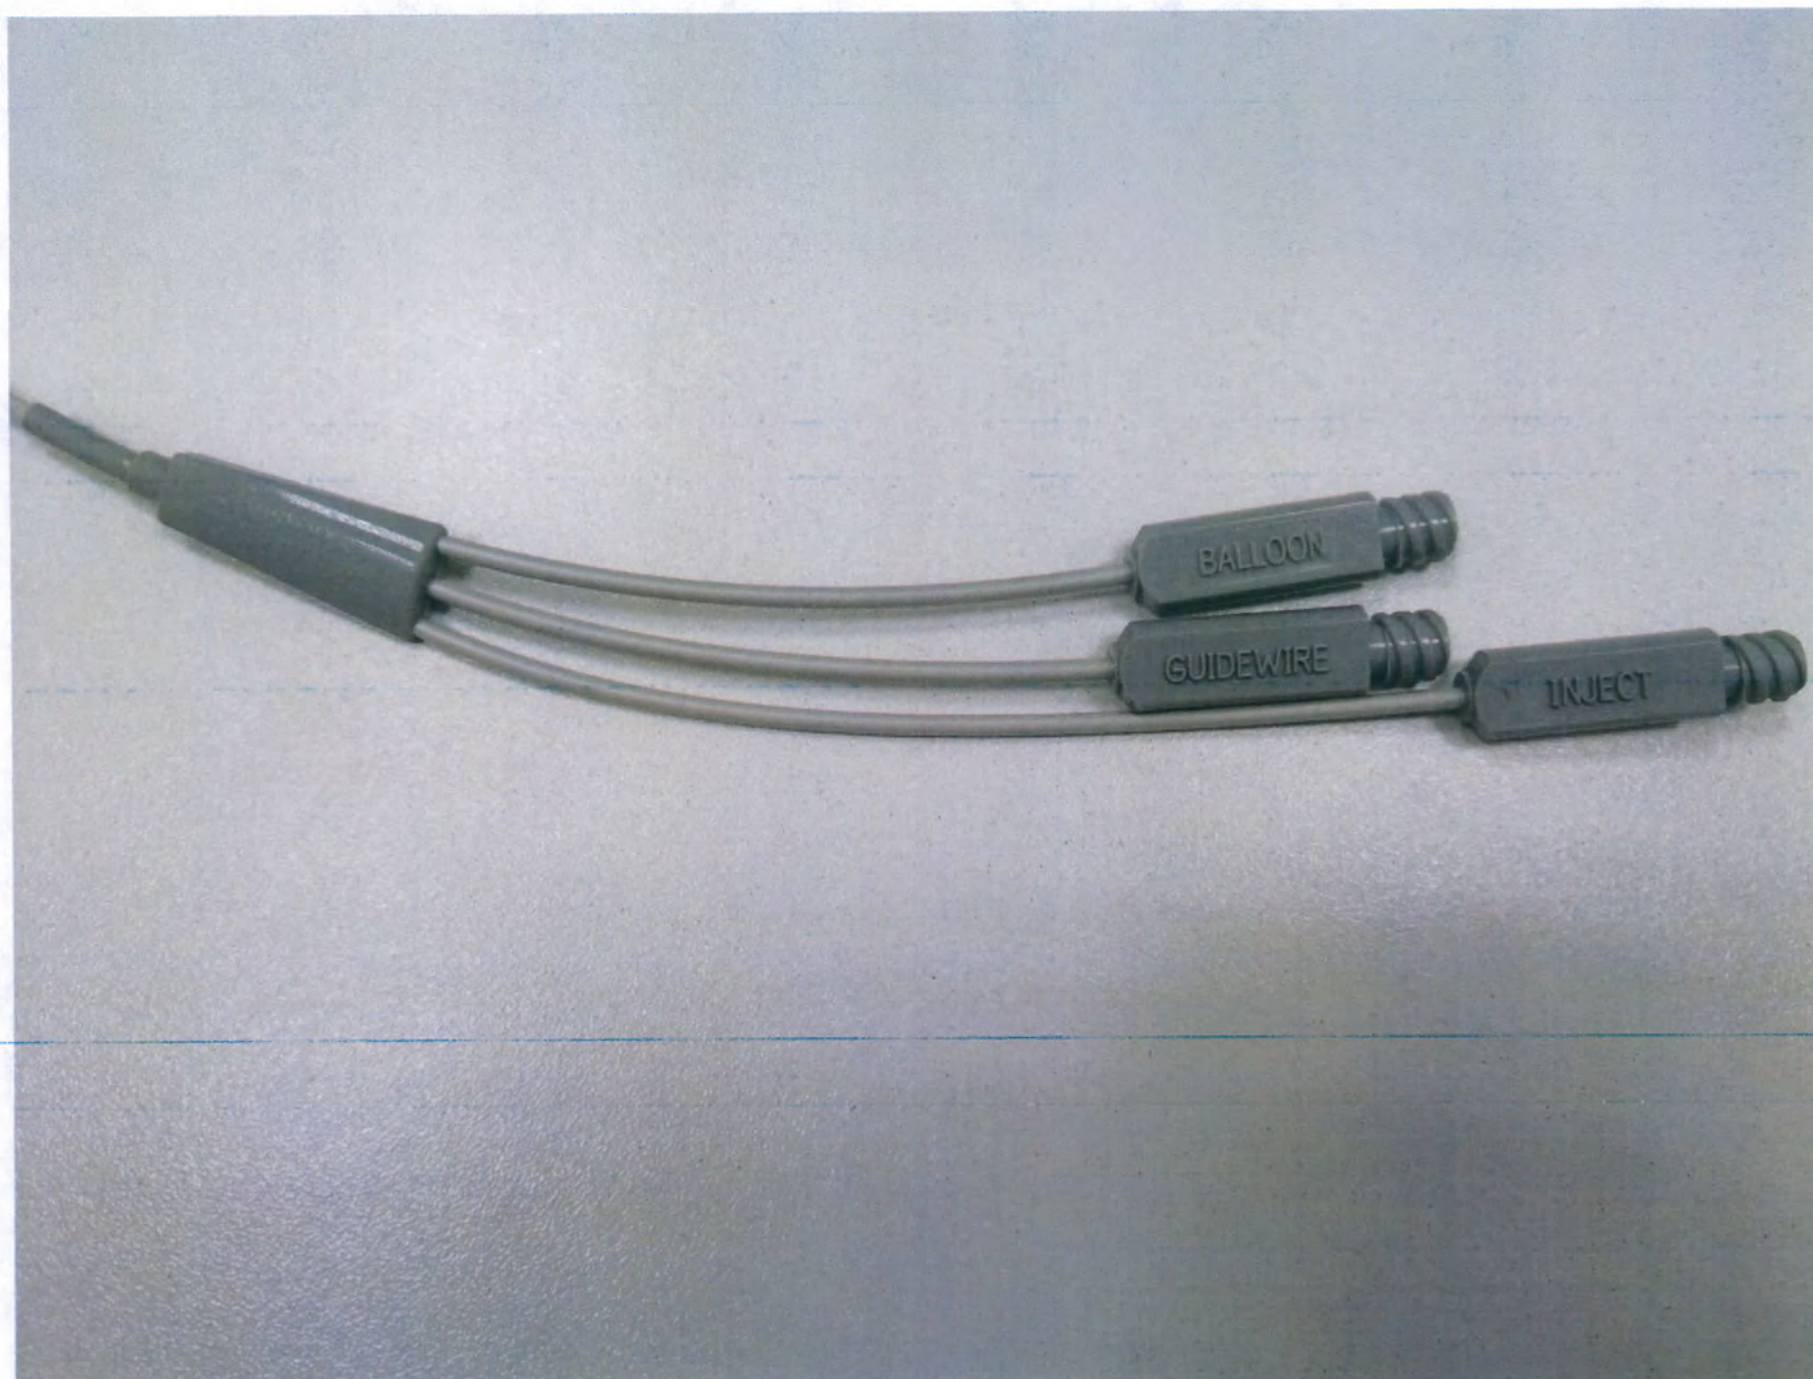


Соединительный узел, трубки и канюли трубок для баллона, инъекции и проводника (вид спереди)

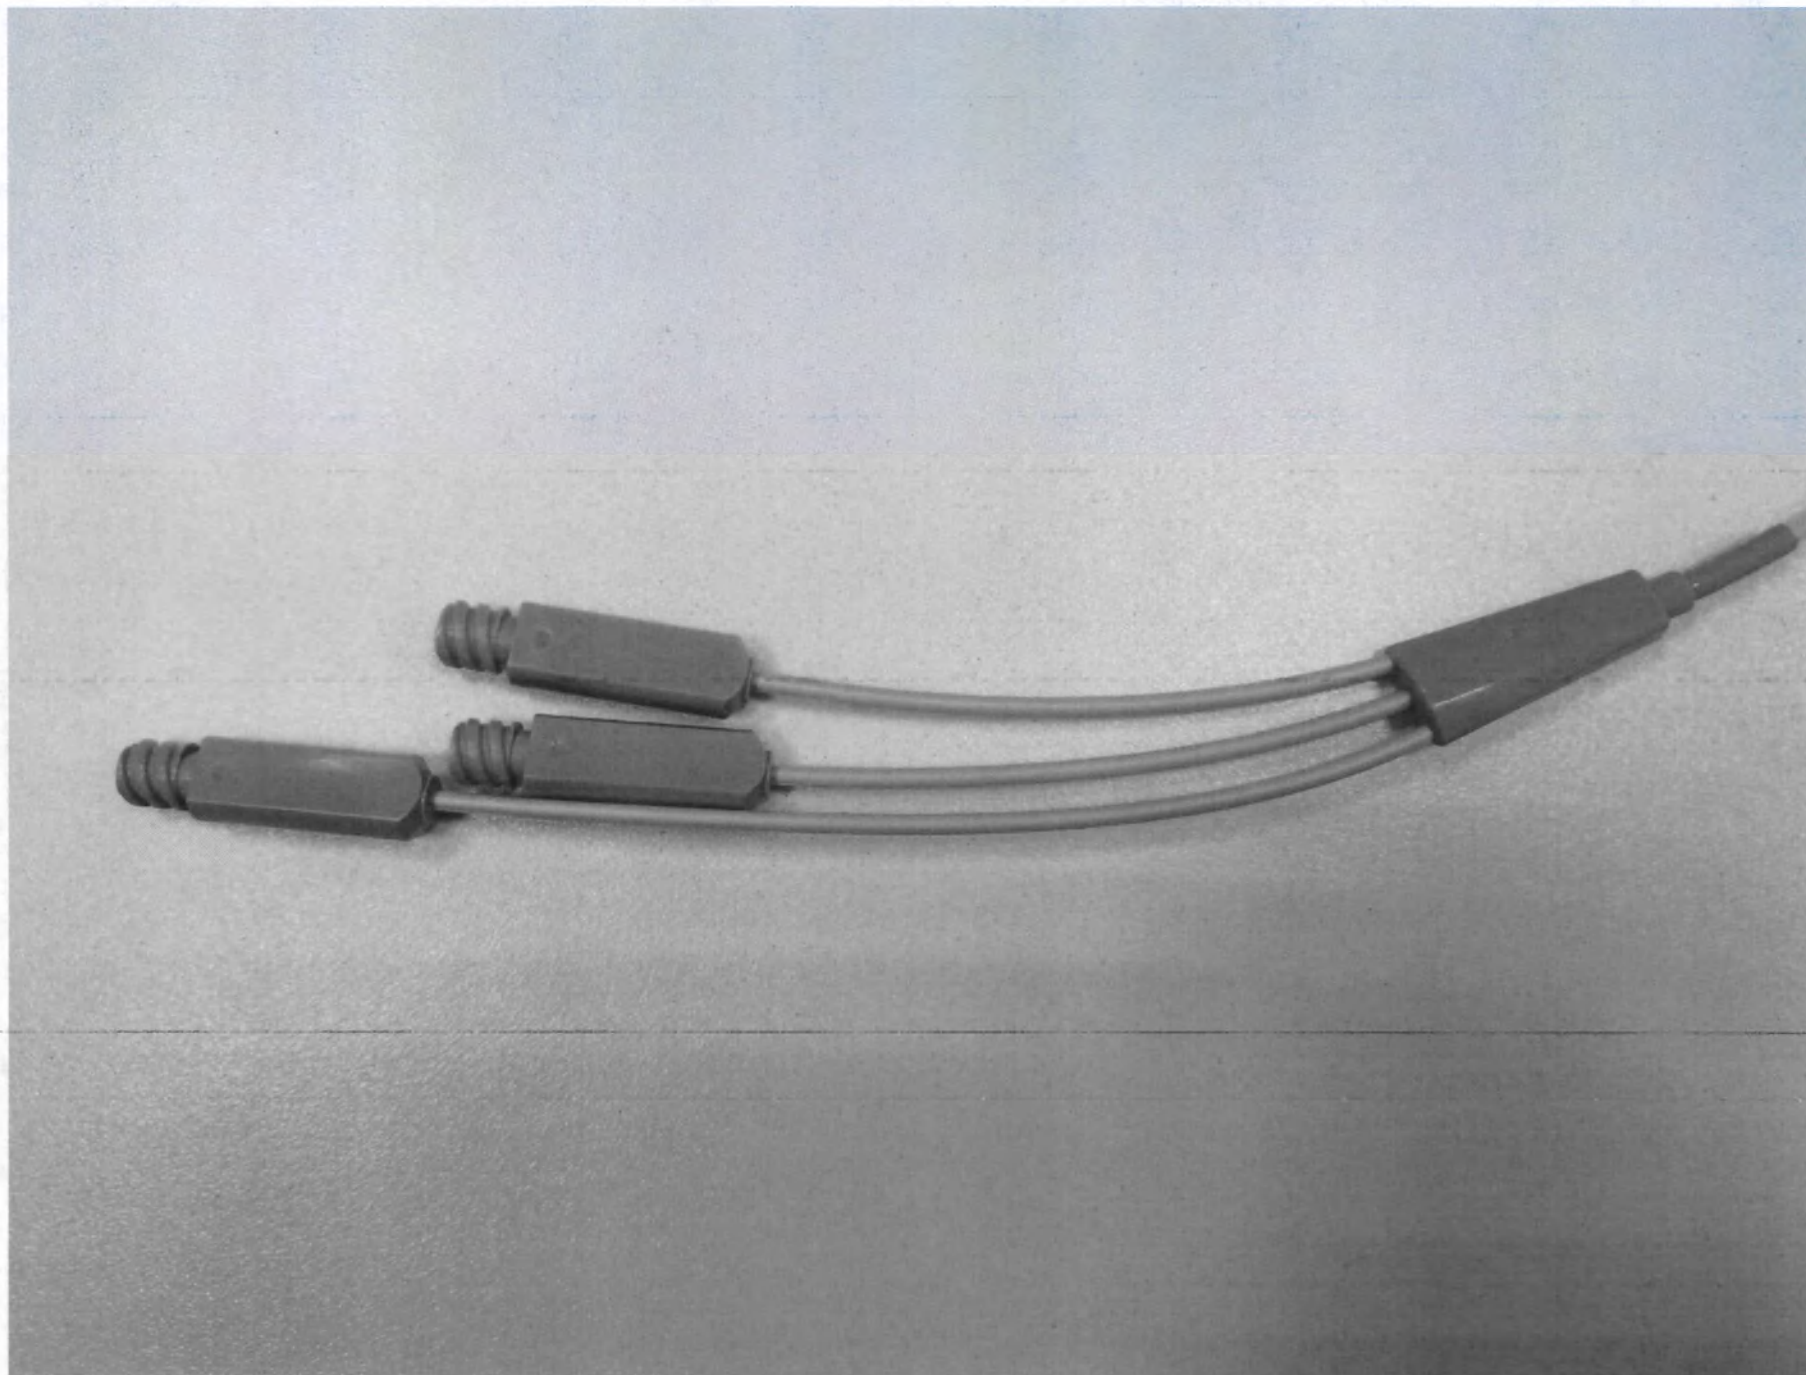


Соединительный узел, трубки и канюли трубок для баллона, инъекции и проводника (вид сзади)

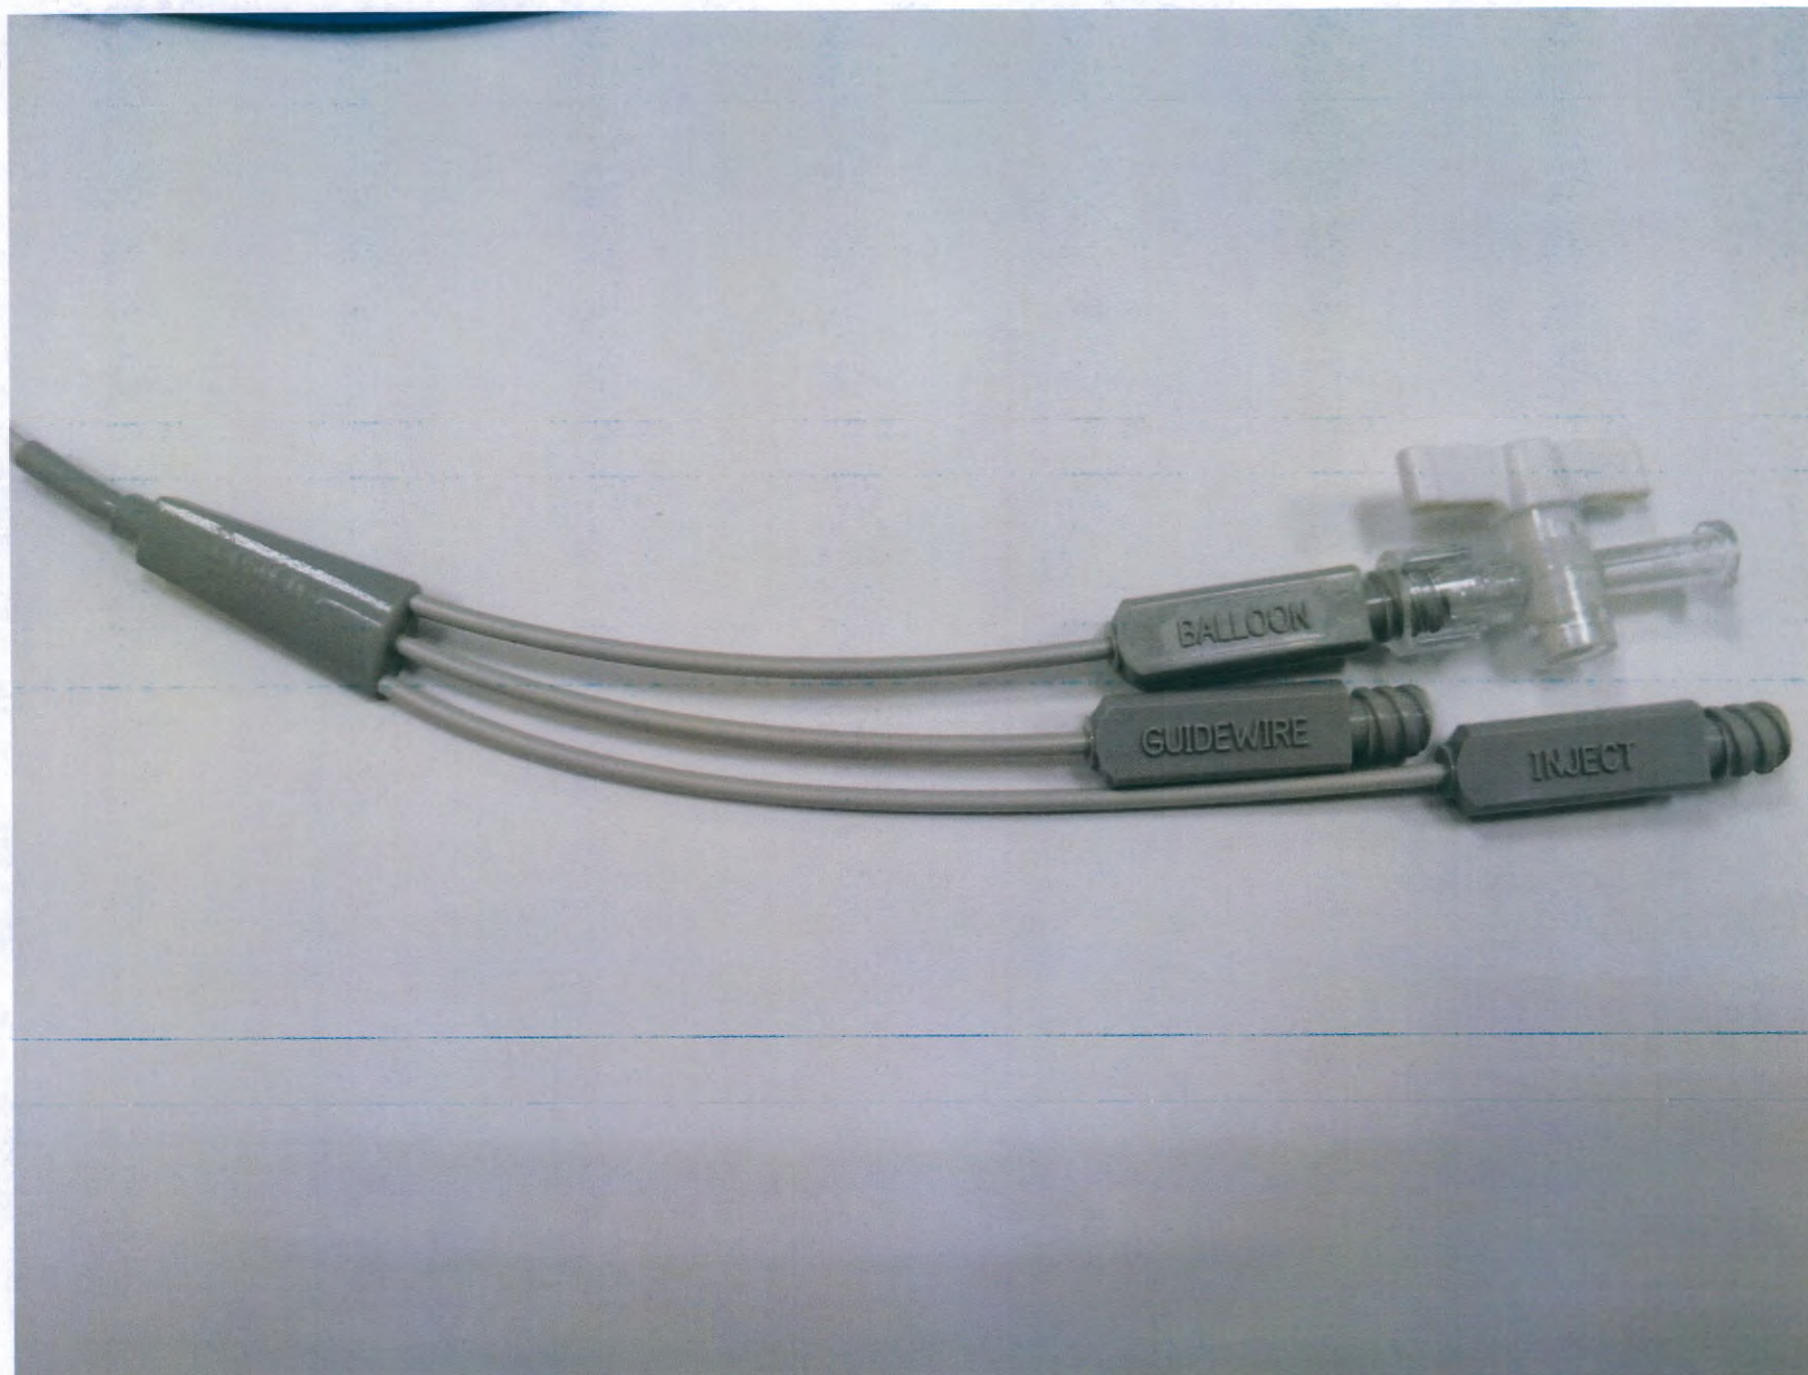


Соединительный узел, трубки и канюли трубок для баллона, инъекции и проводника. На трубке для баллона зафиксирован кран
запорный

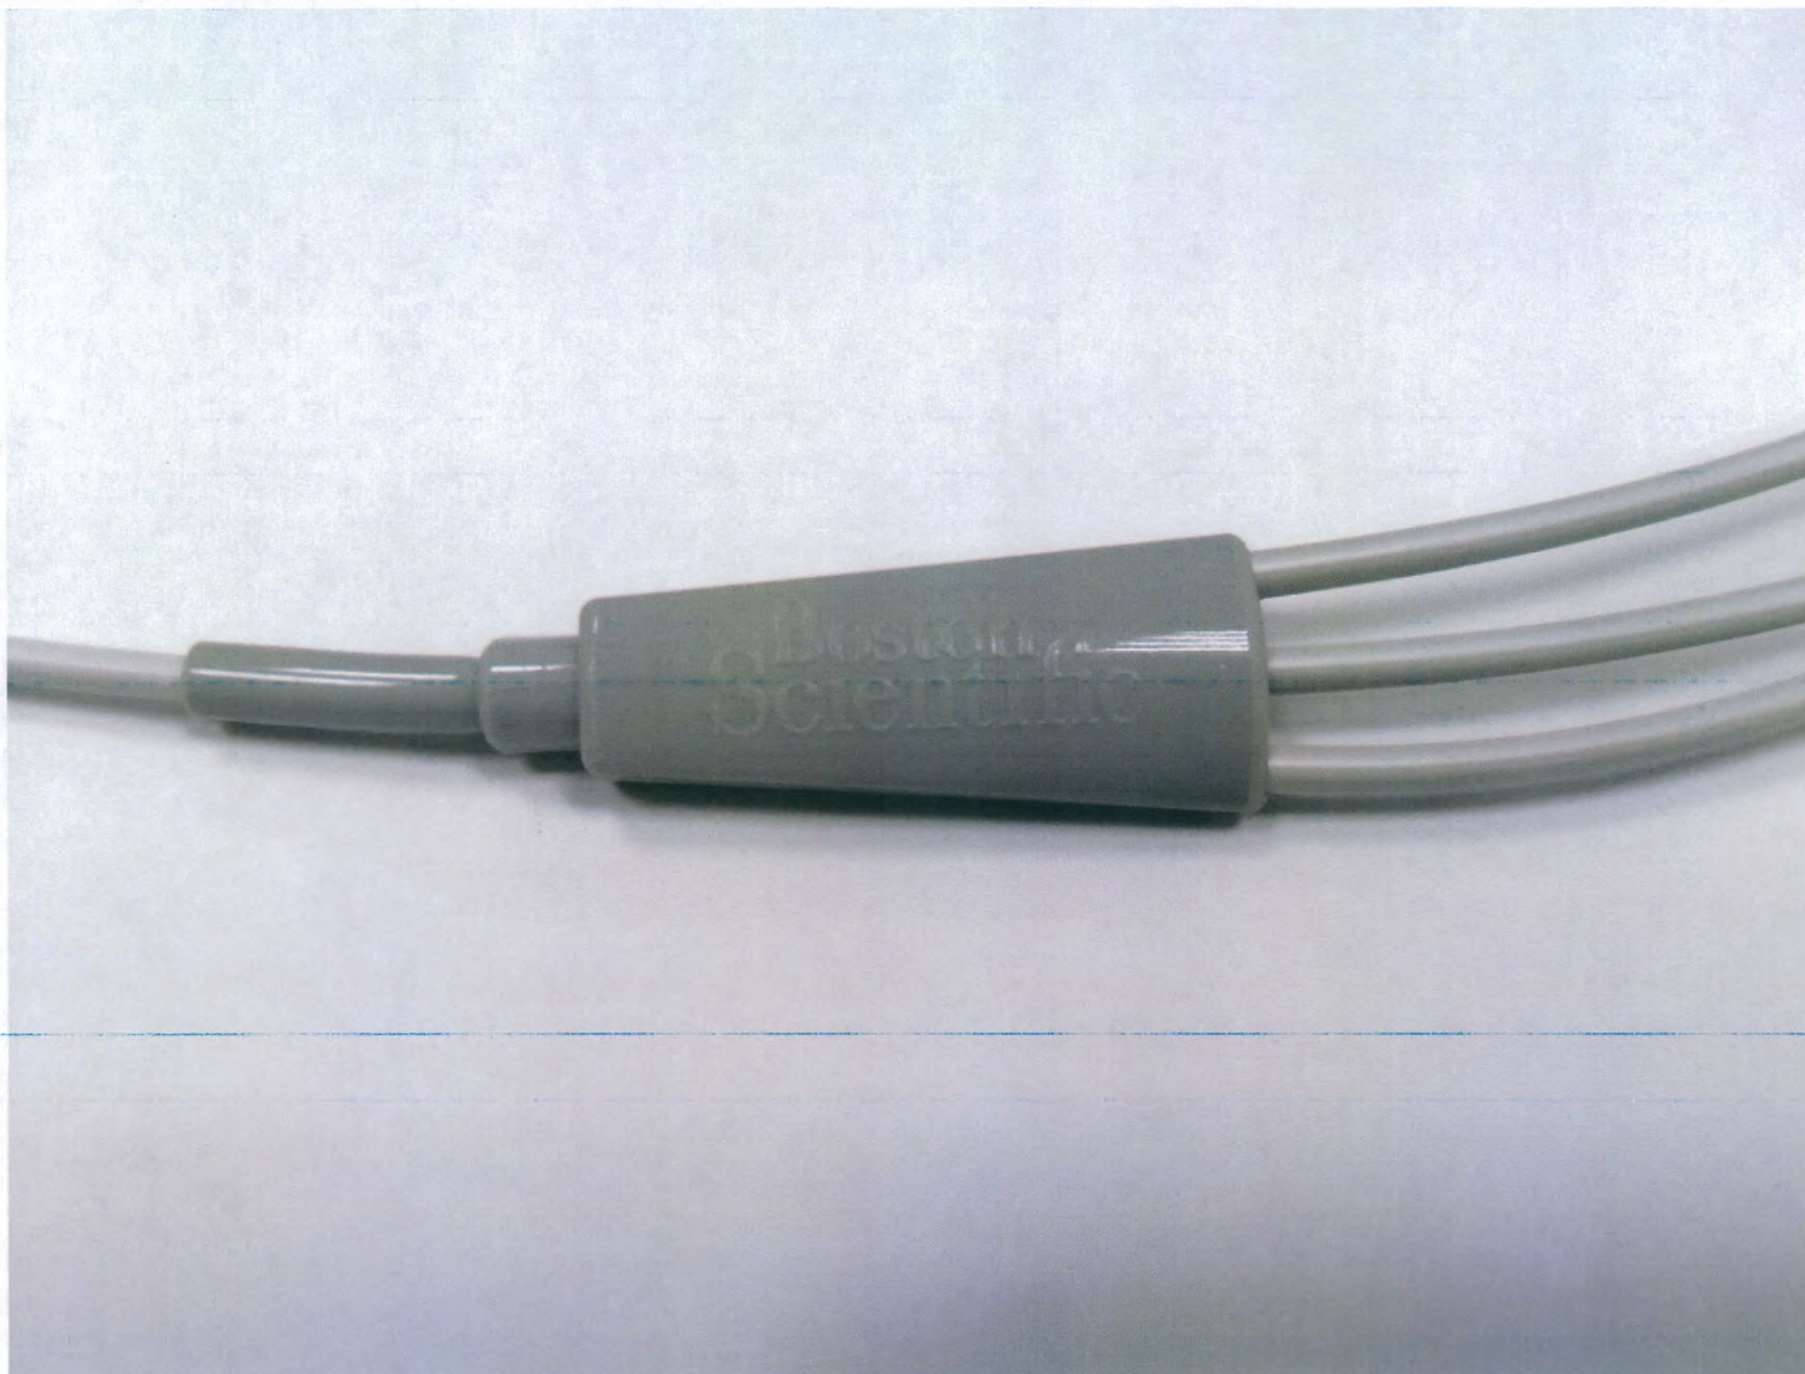

Соединительный узел

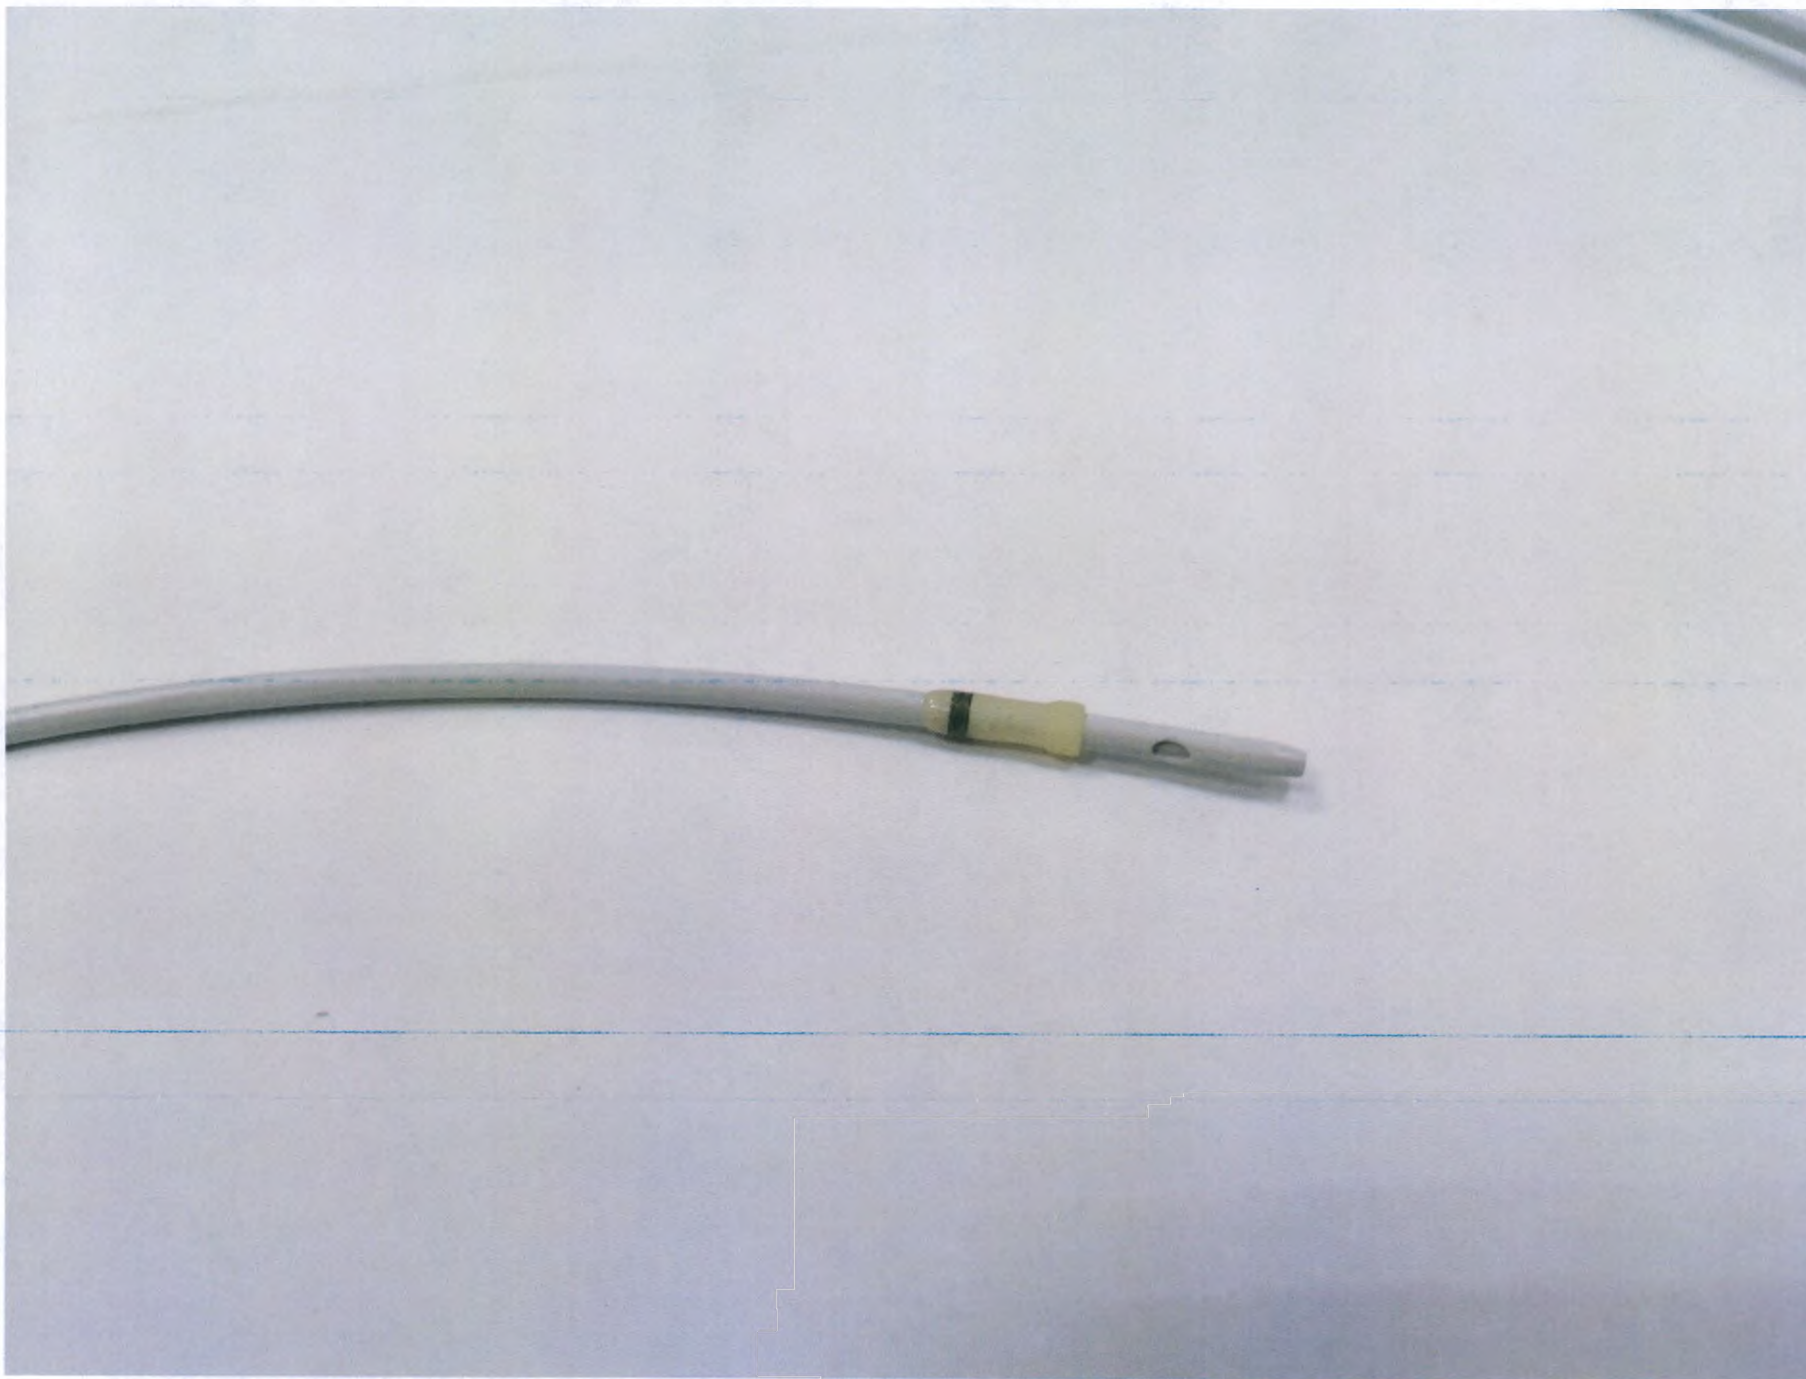

Дистальный конец катетера, баллон (9 мм/12 мм), рентгеноконтрастный маркер, порт для инъекции (выше баллона)

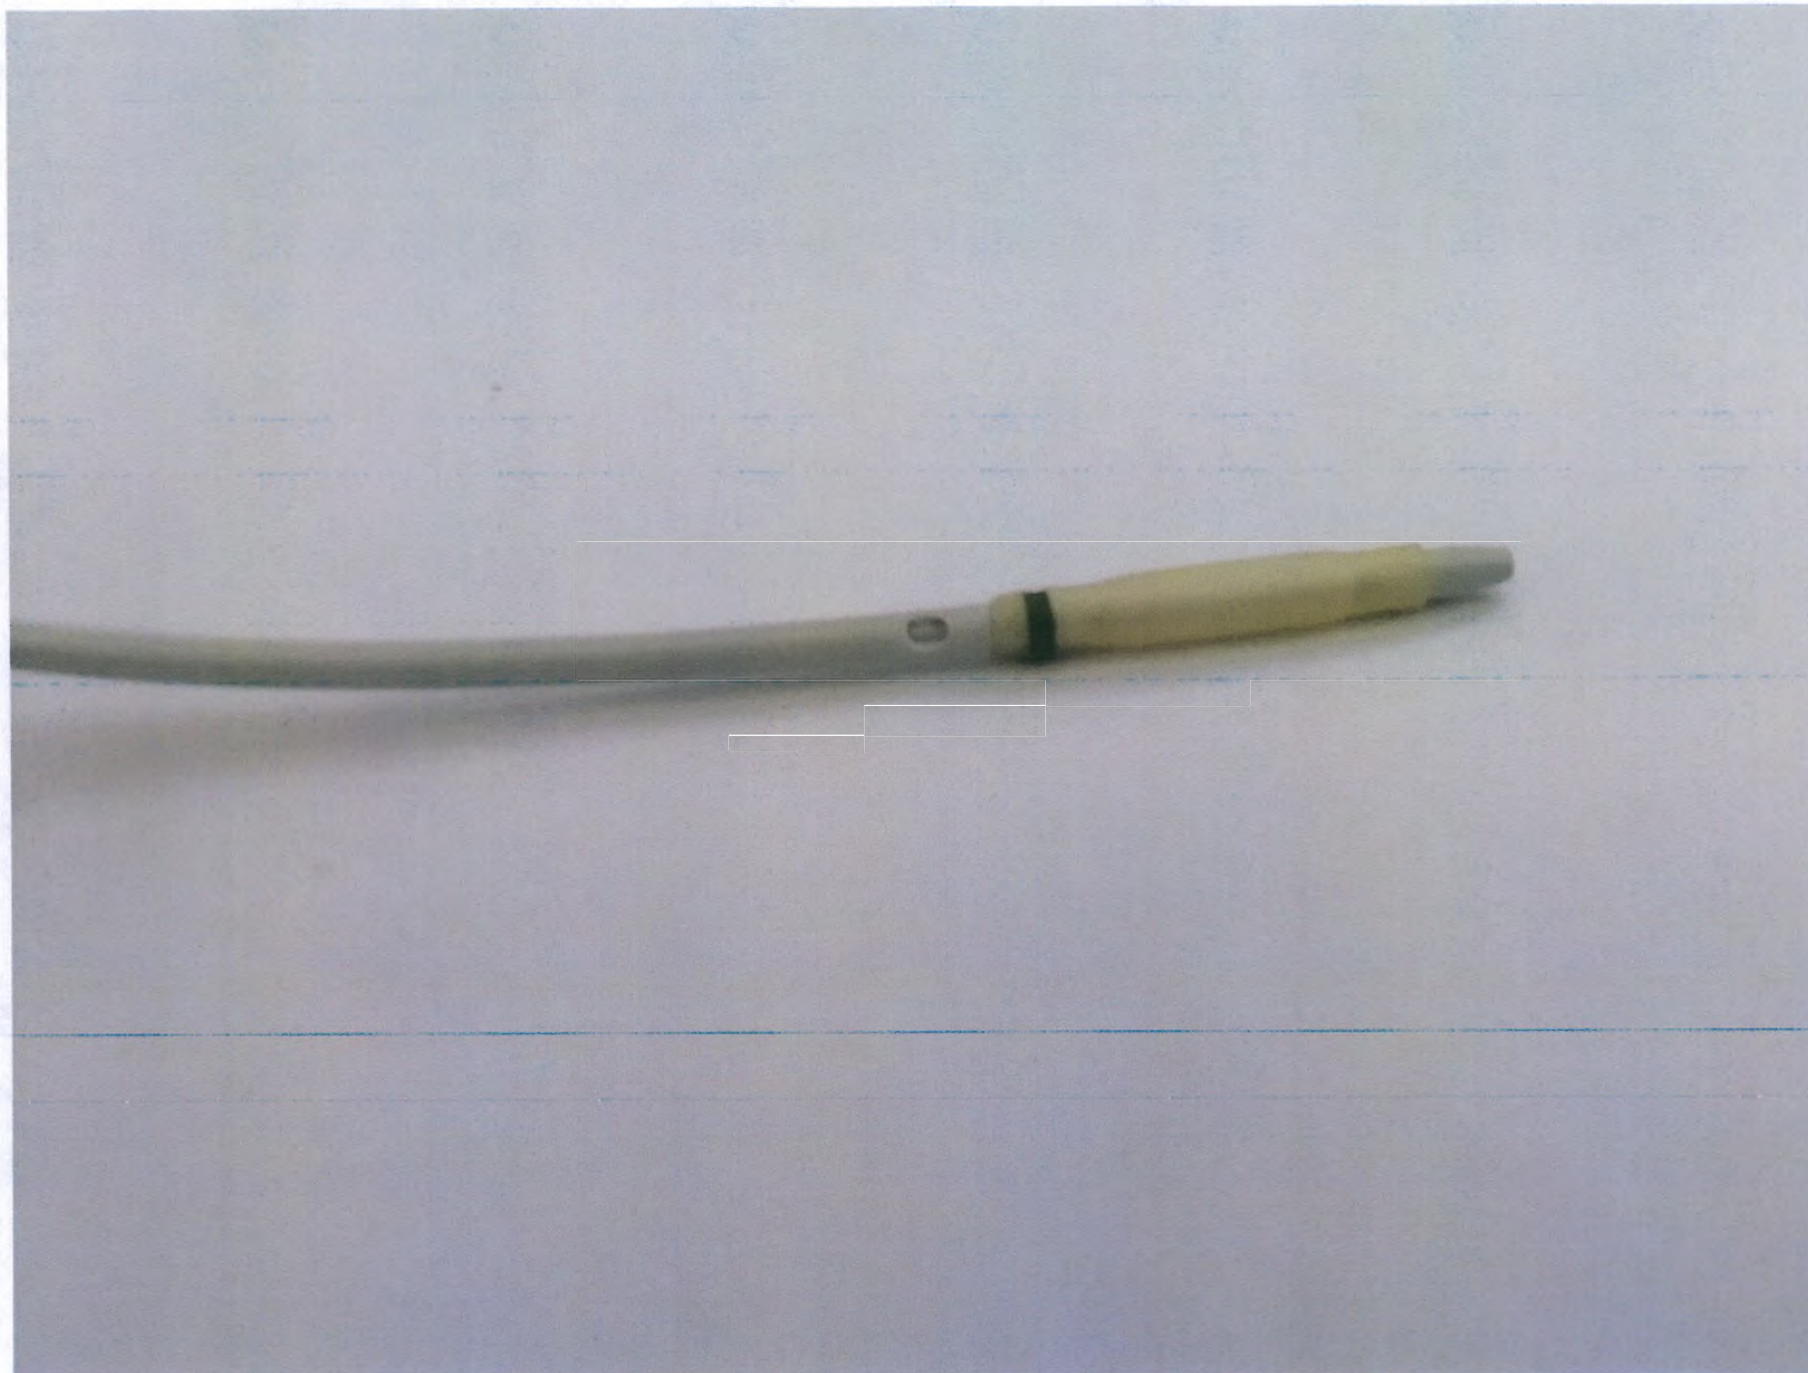

Дистальный конец катетера, баллон (15 мм/18 мм), рентгеноконтрастный маркер, порт для инъекции (ниже баллона)

Boston
Scientific

Extractor™ Pro XL

Retrieval Balloon Catheter

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	6
Mode d'emploi	10
Gebrauchsanweisung	15
Istruzioni per l'uso	20
Gebruiksaanwijzing	25
Instruções de Utilização	30



90965435-01

2014-11

Инструкция по применению (вид спереди)

**ARG Argentina
Local Contact**

Para obtener información de
contacto de Boston Scientific
Argentina SA, por favor, acceda al
link www.bostonscientific.com/arg

**BRA Brazil
Local Contact**

Para informações de contato da
Boston Scientific do Brasil Ltda,
por favor, acesse o link
www.bostonscientific.com/bra

**EC REP EU Authorized
Representative**

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

**AUS Australian
Sponsor Address**

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

**Legal
Manufacturer**

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001


 **Do not use if package
is damaged.**

 **Recyclable
Package**


CE 0344

© 2014 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.


Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX-S, в вариантах исполнения

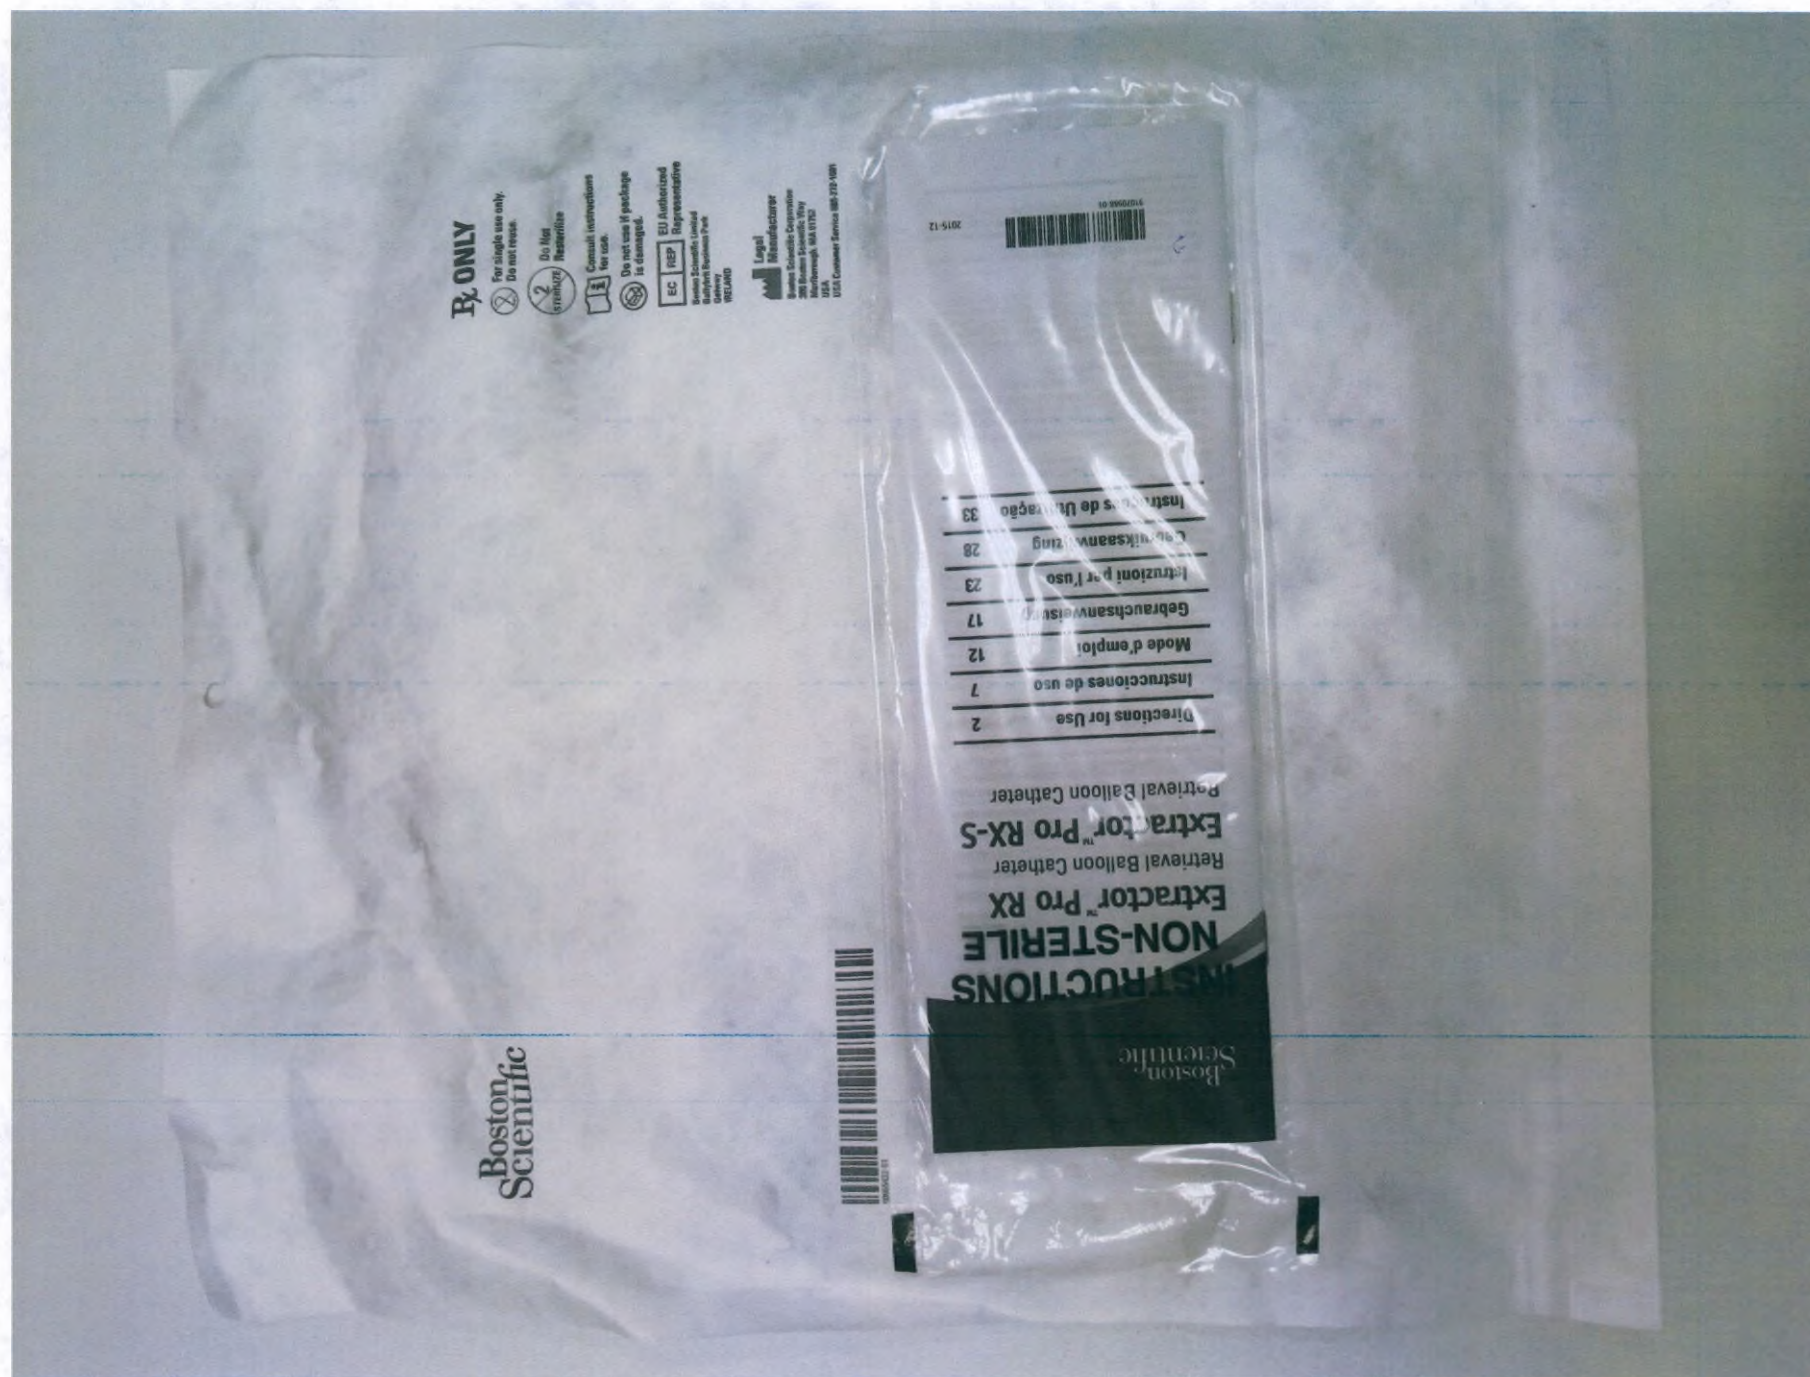


Катетер баллонный для литоэкстракции Extractor Pro RX-S в упаковке (пакете) (вид сзади)

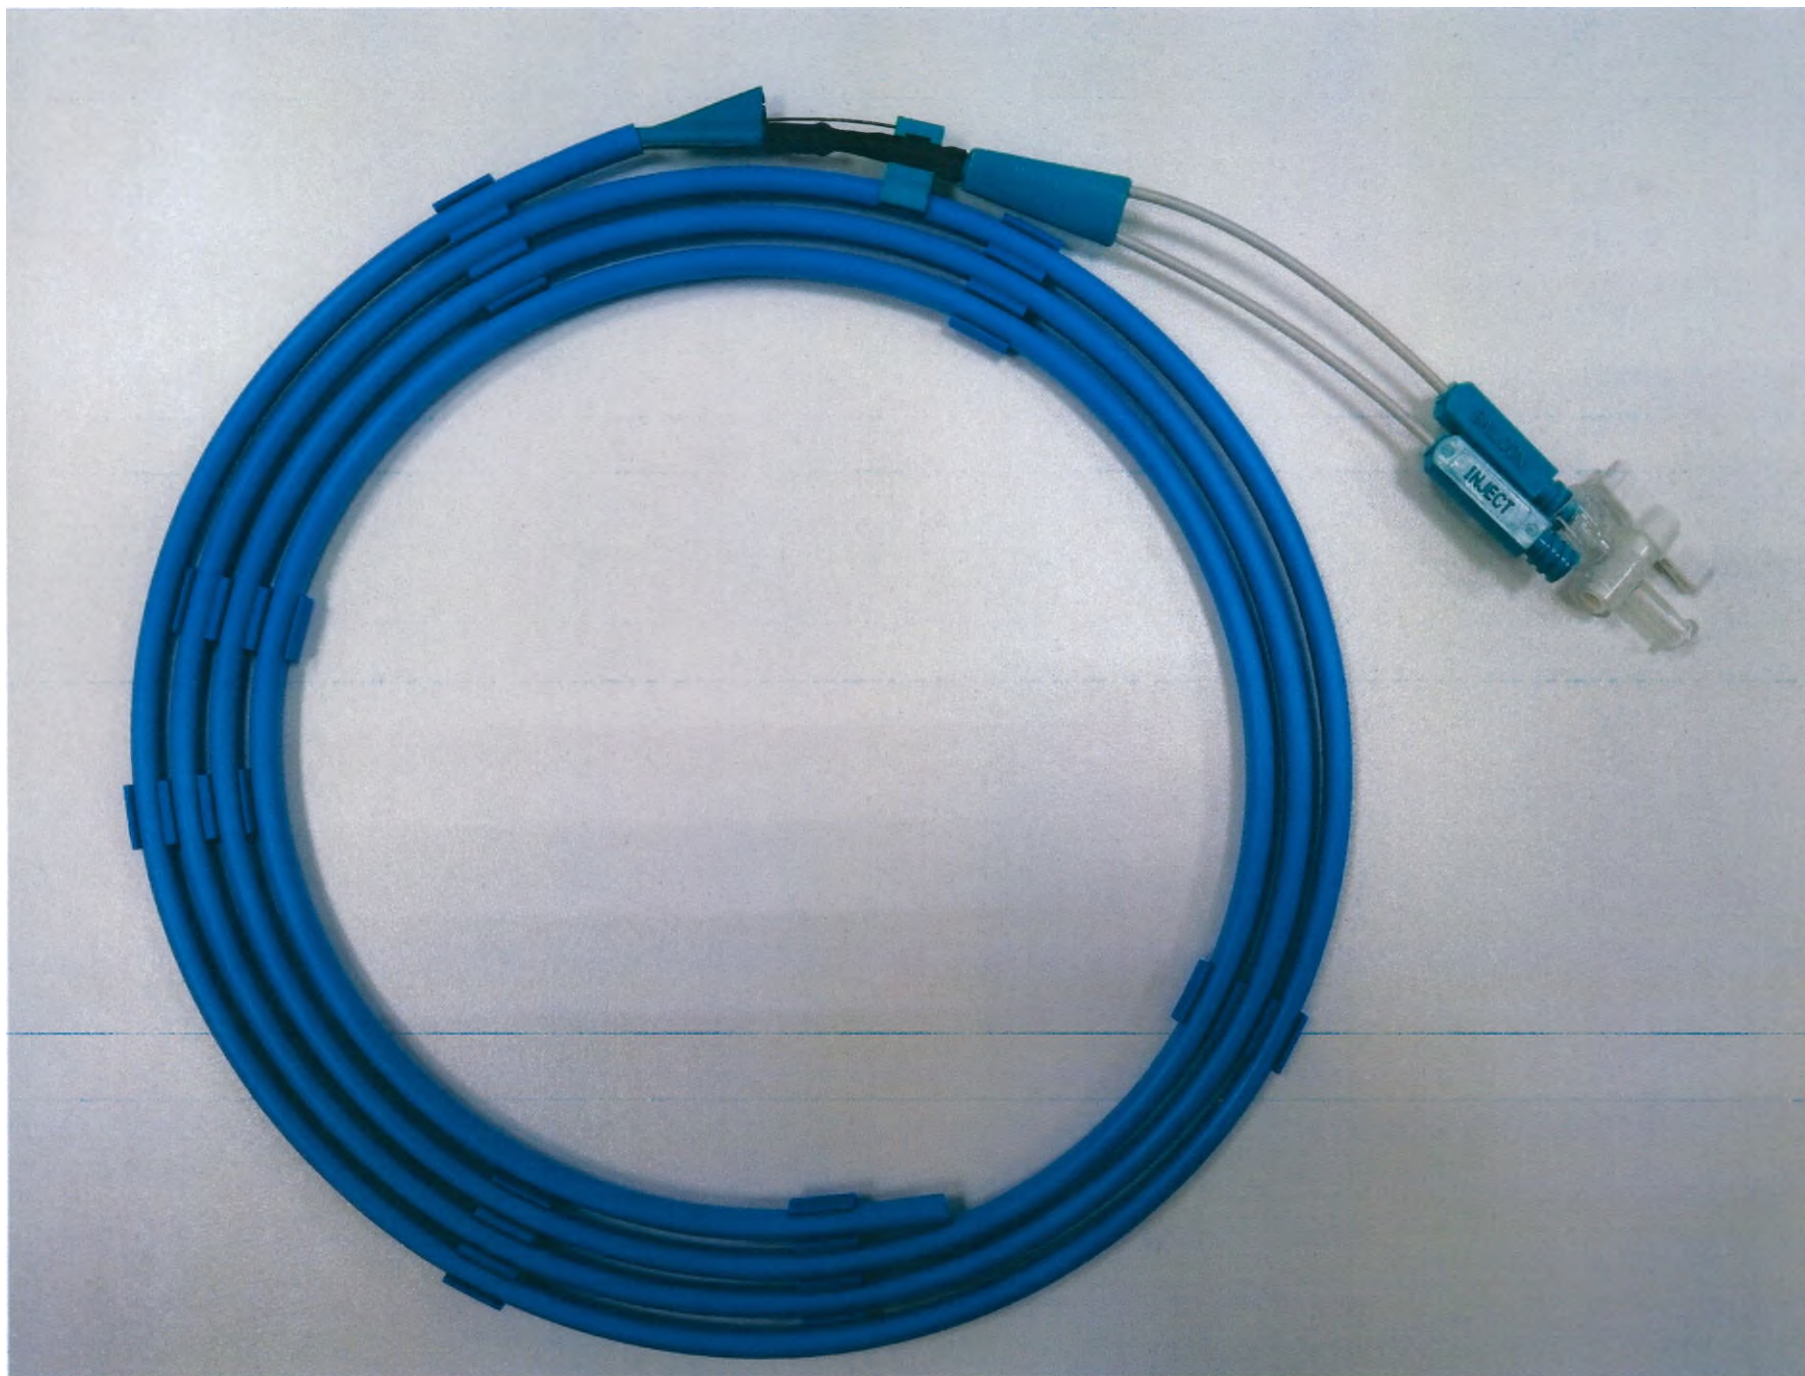


Общий вид катетера баллонного для литоэкстракции Extractor Pro RX-S в защитной трубке с зажимами для крепления защитной трубки

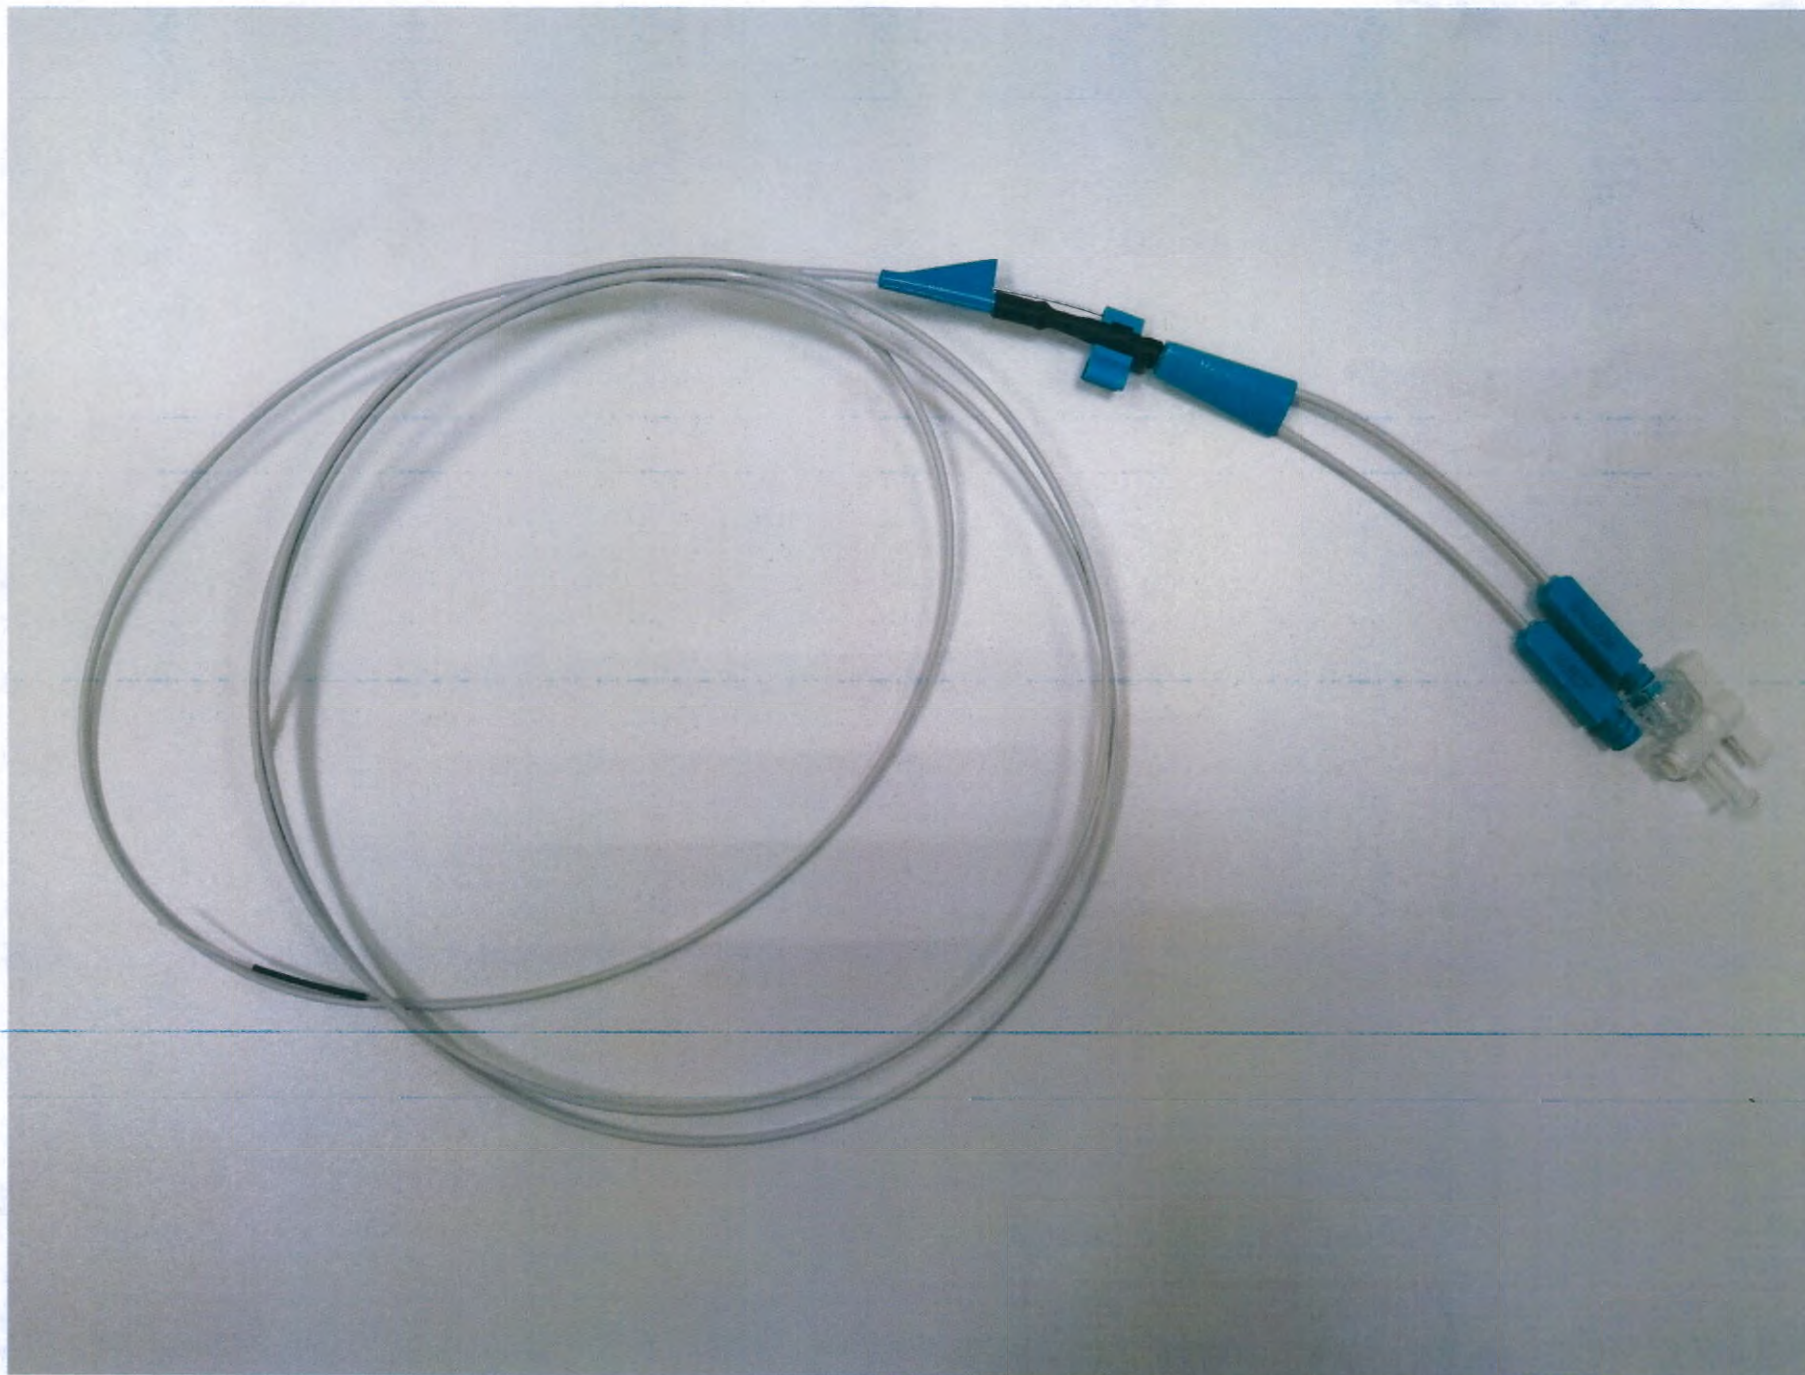


Общий вид катетера баллонного для литоэкстракции Extractor Pro RX-S

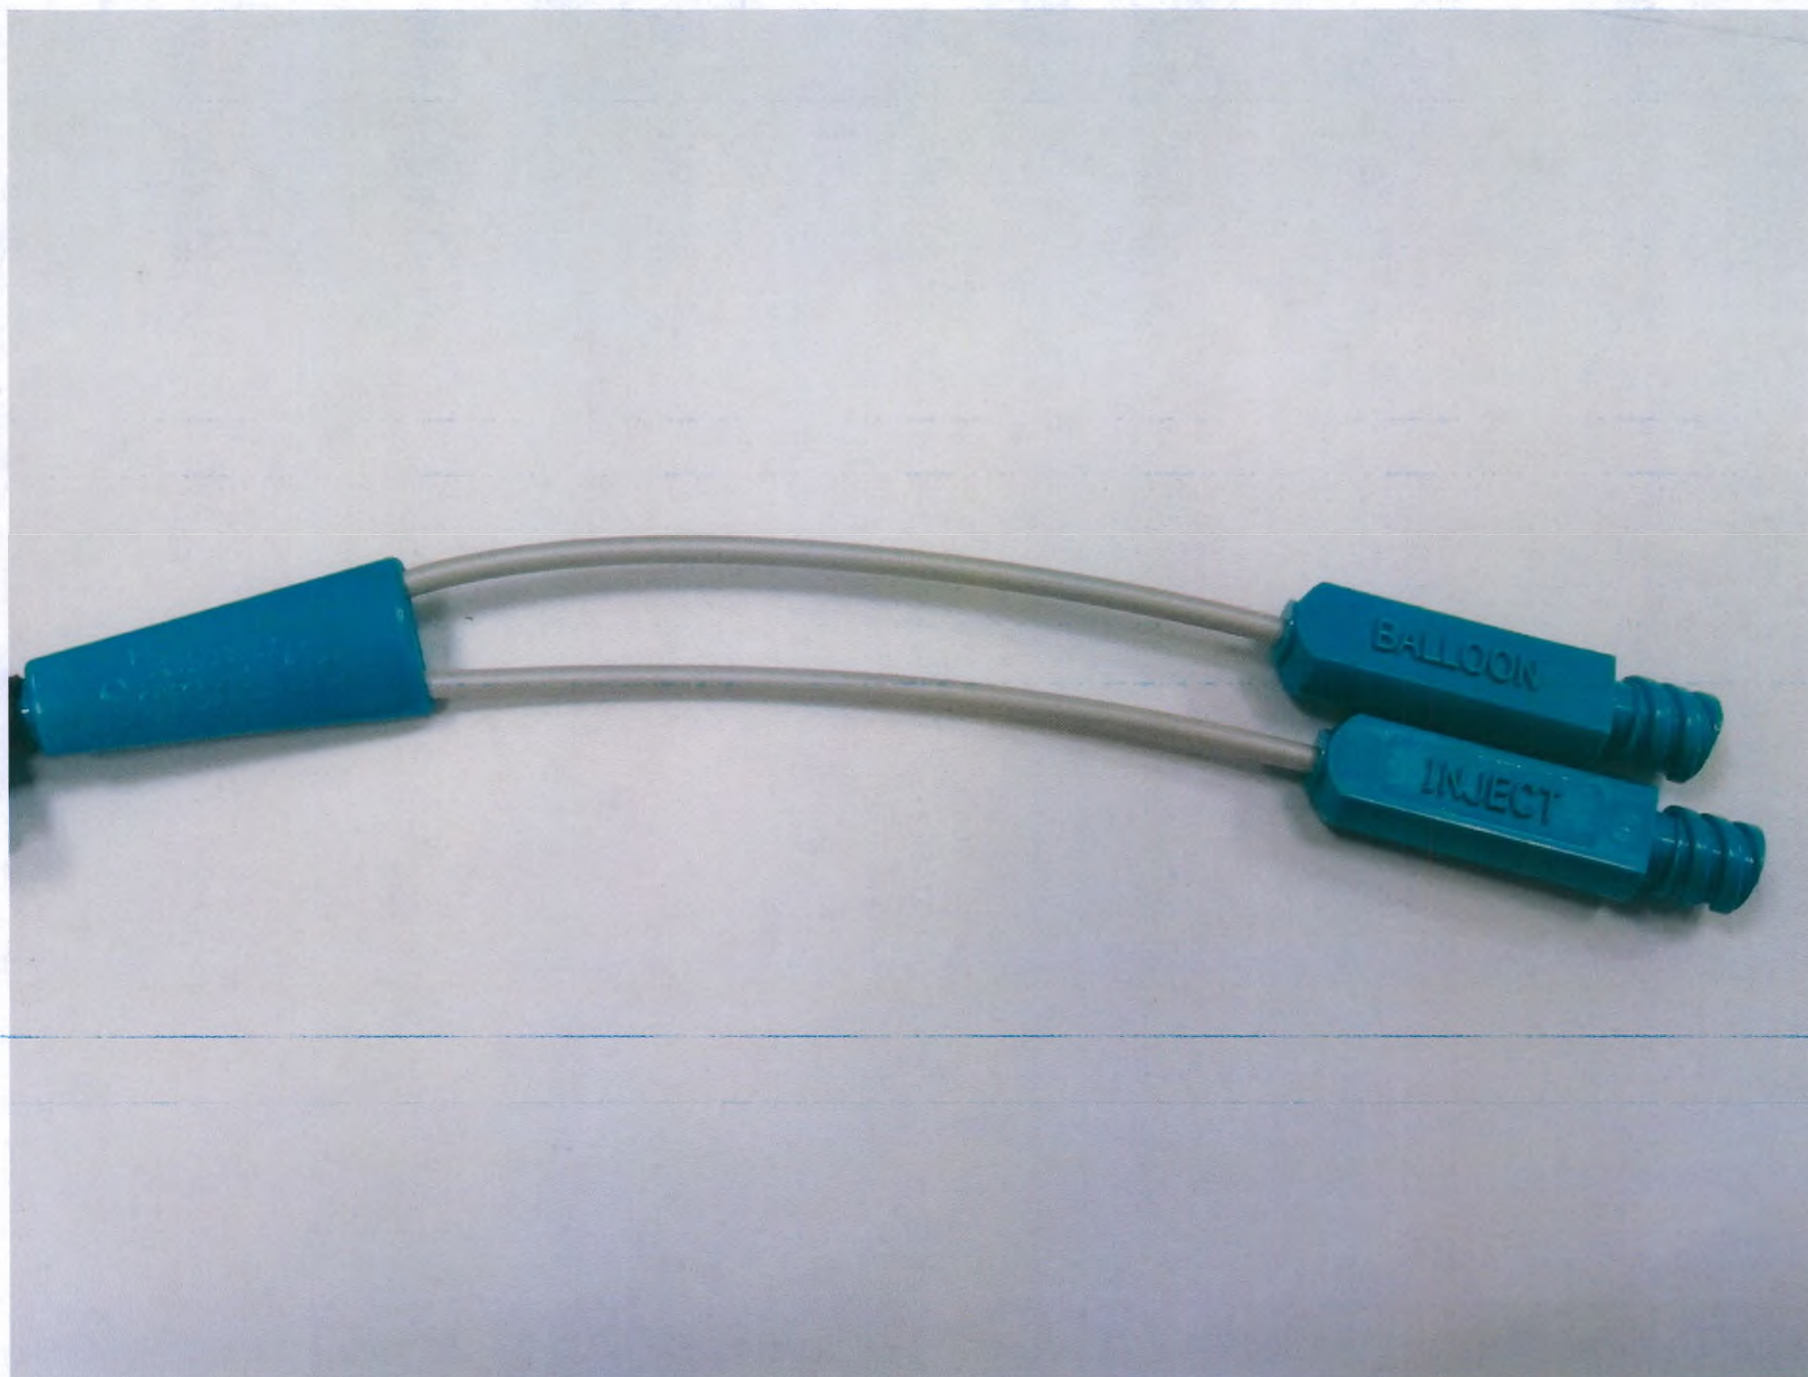


Соединительный узел, трубки и канюли трубок для баллона и инъекции (вид спереди)

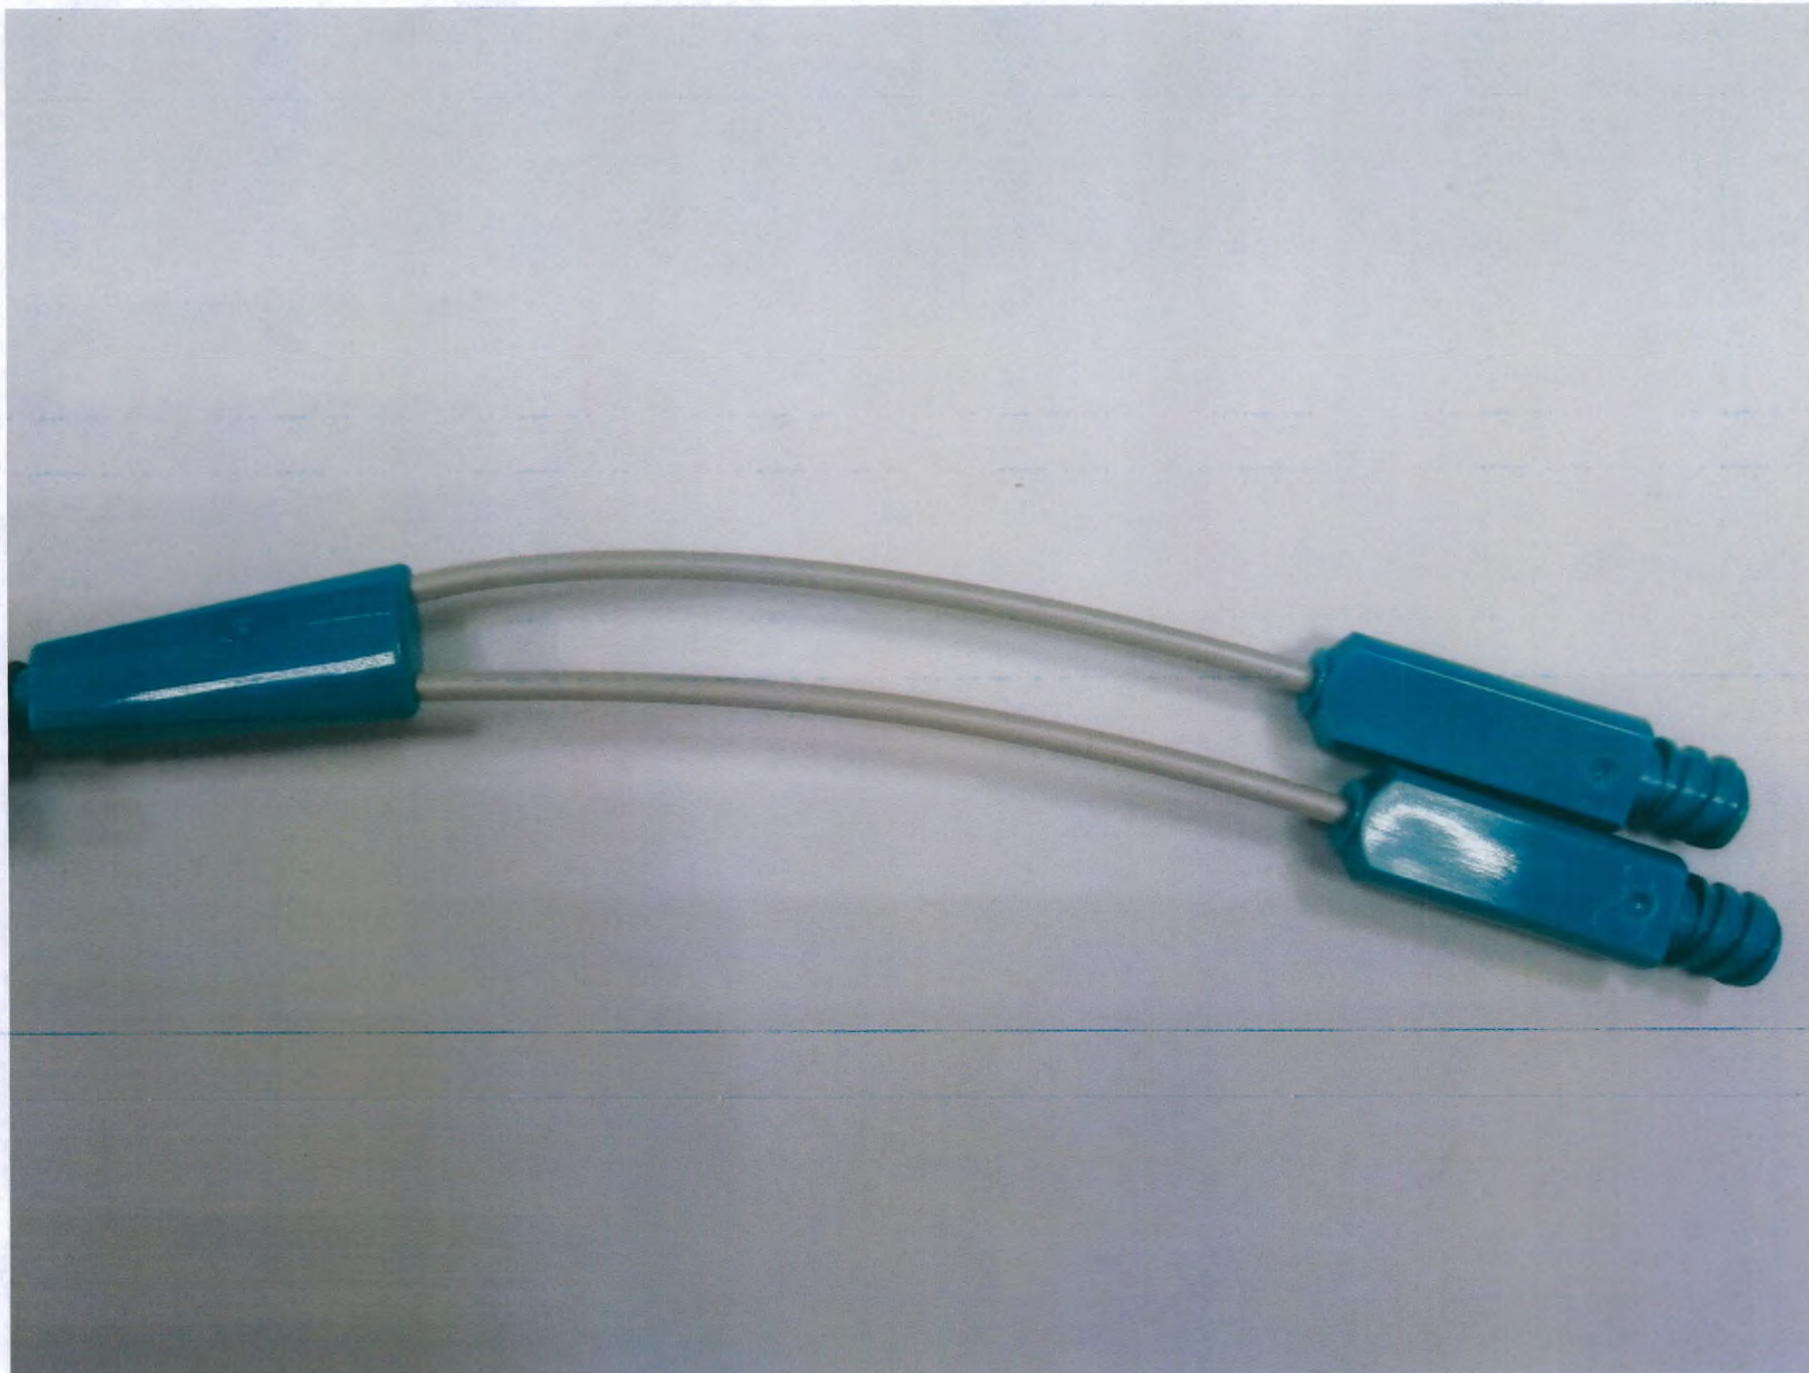


Соединительный узел, трубки и канюли трубок для баллона и инъекции (вид сзади)

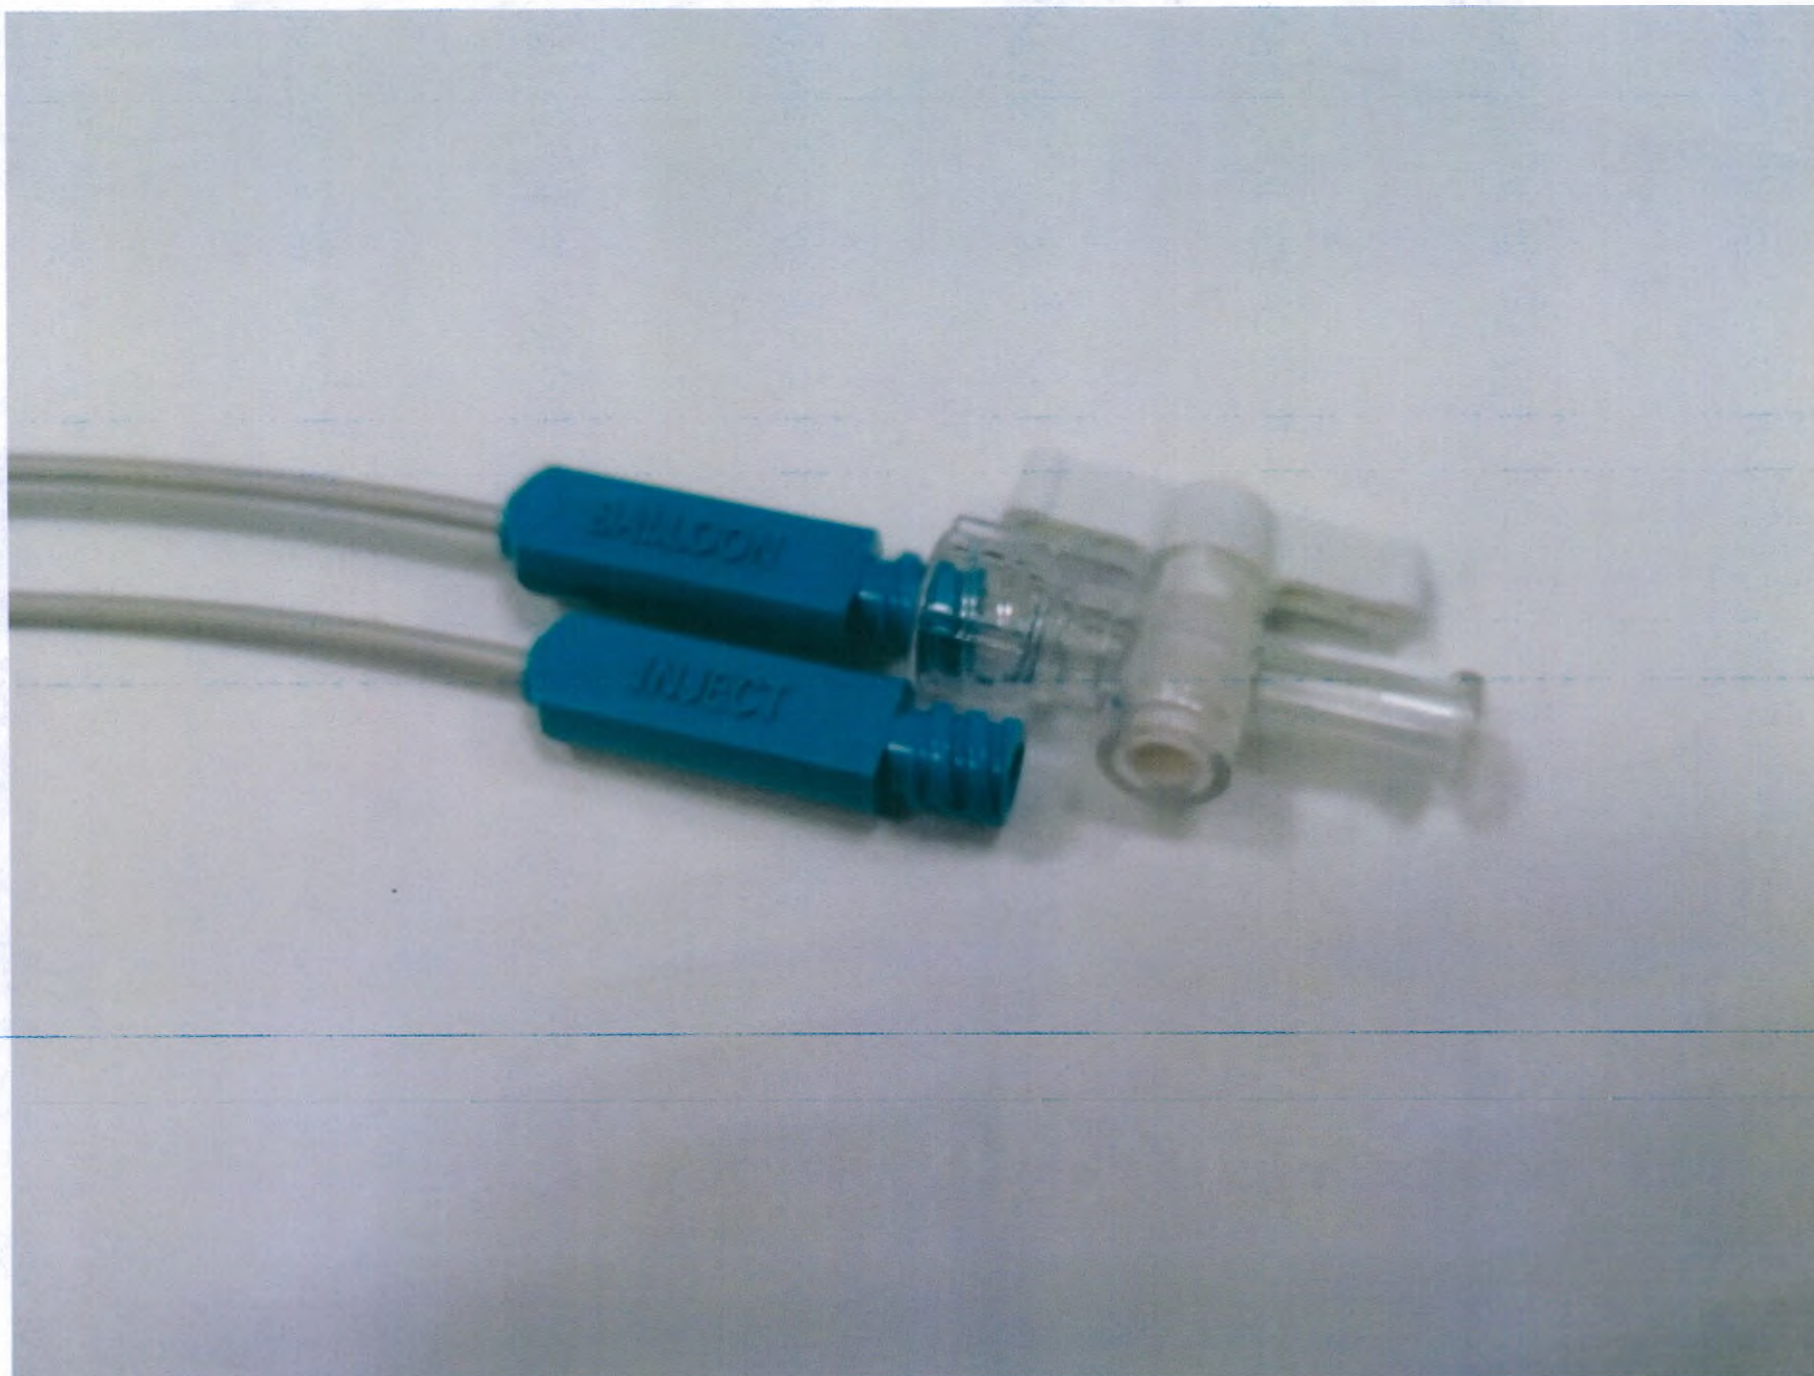


Трубки и канюли трубок для баллона и инъекции. На трубке для баллона зафиксирован кран запорный

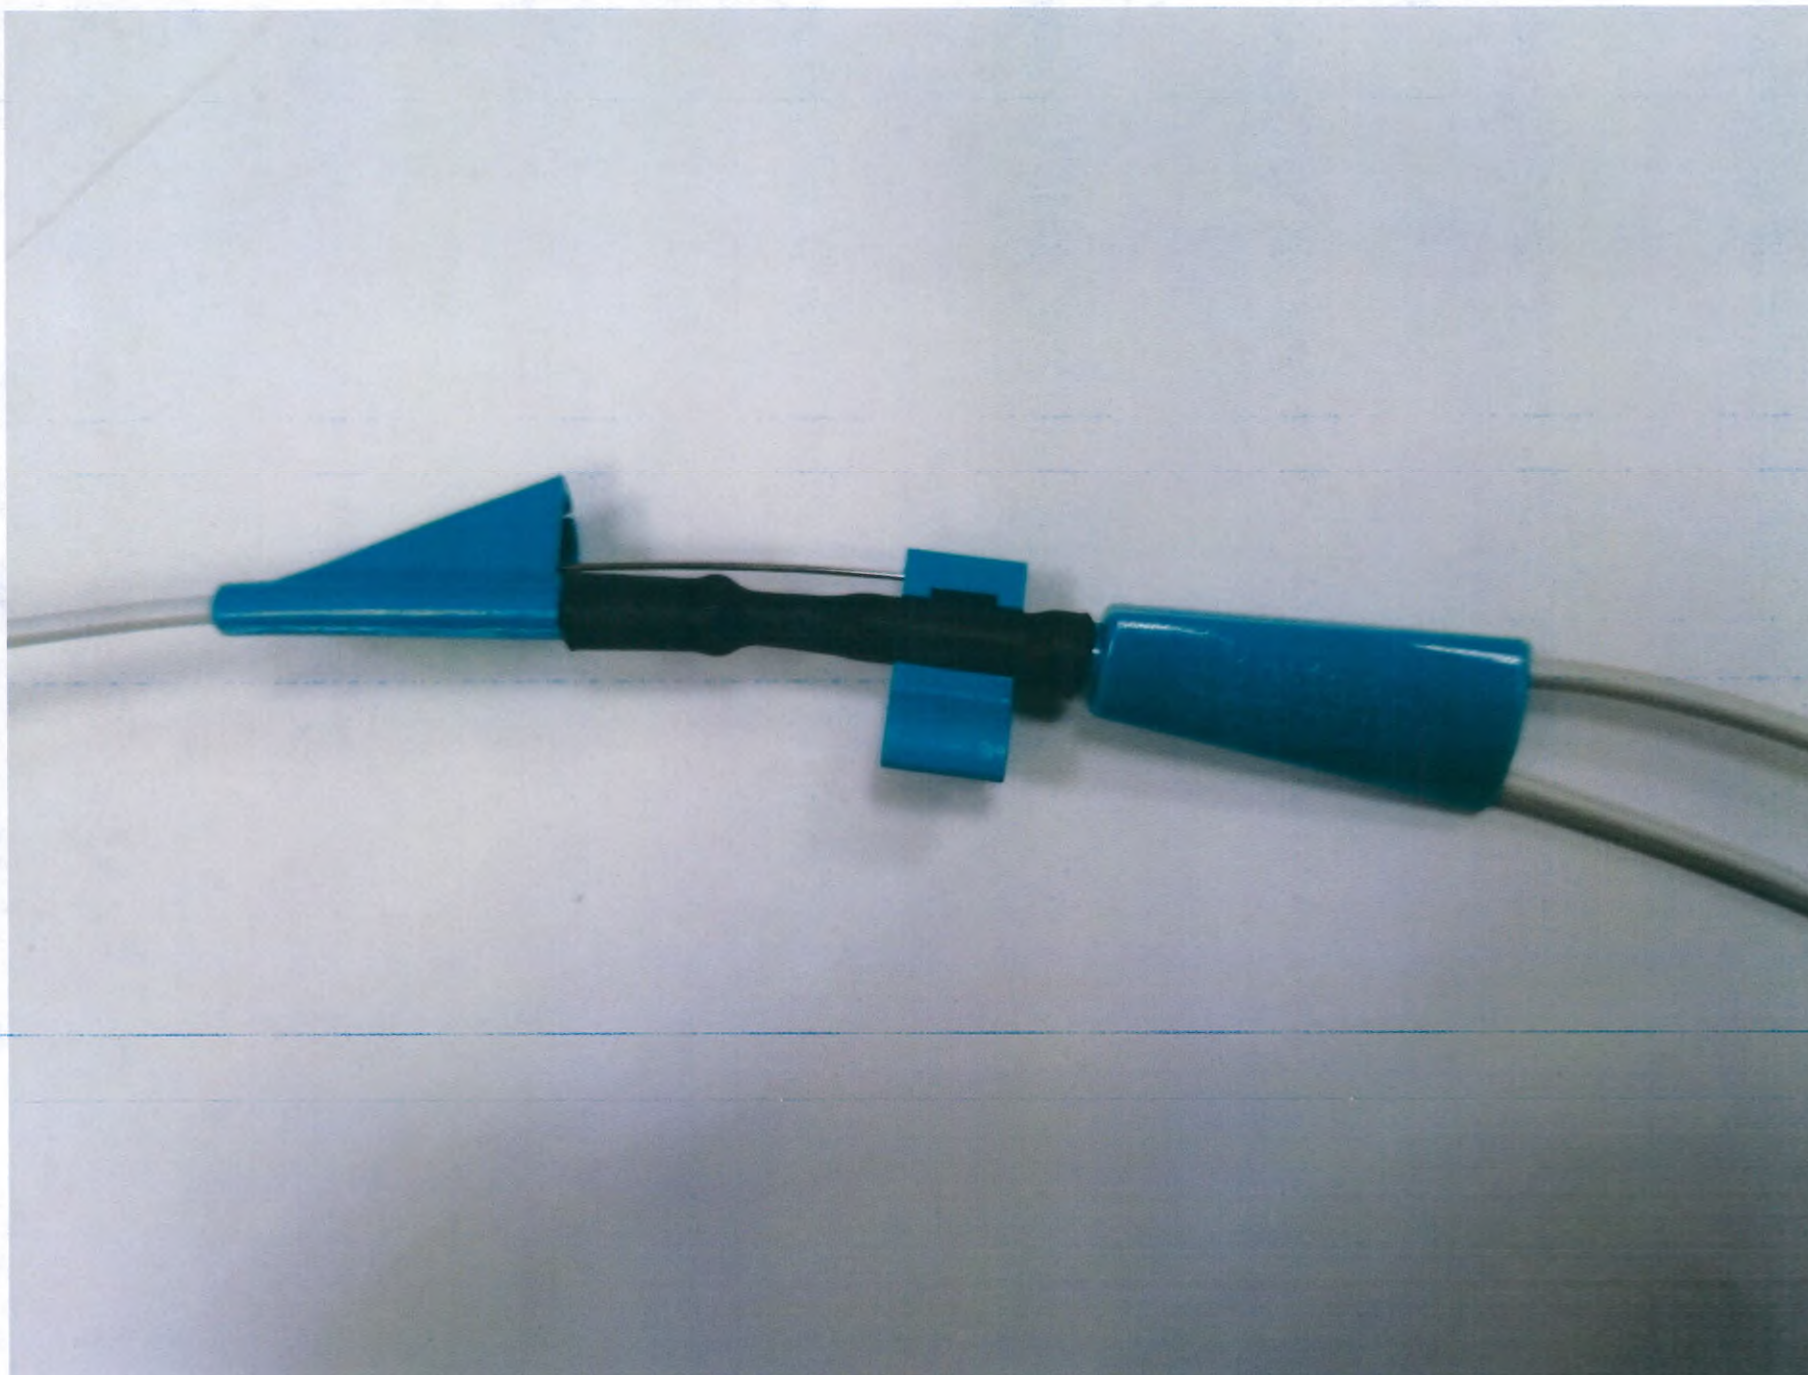


Соединительный узел, интродьюсер проводника и стилет с зажимом стилета

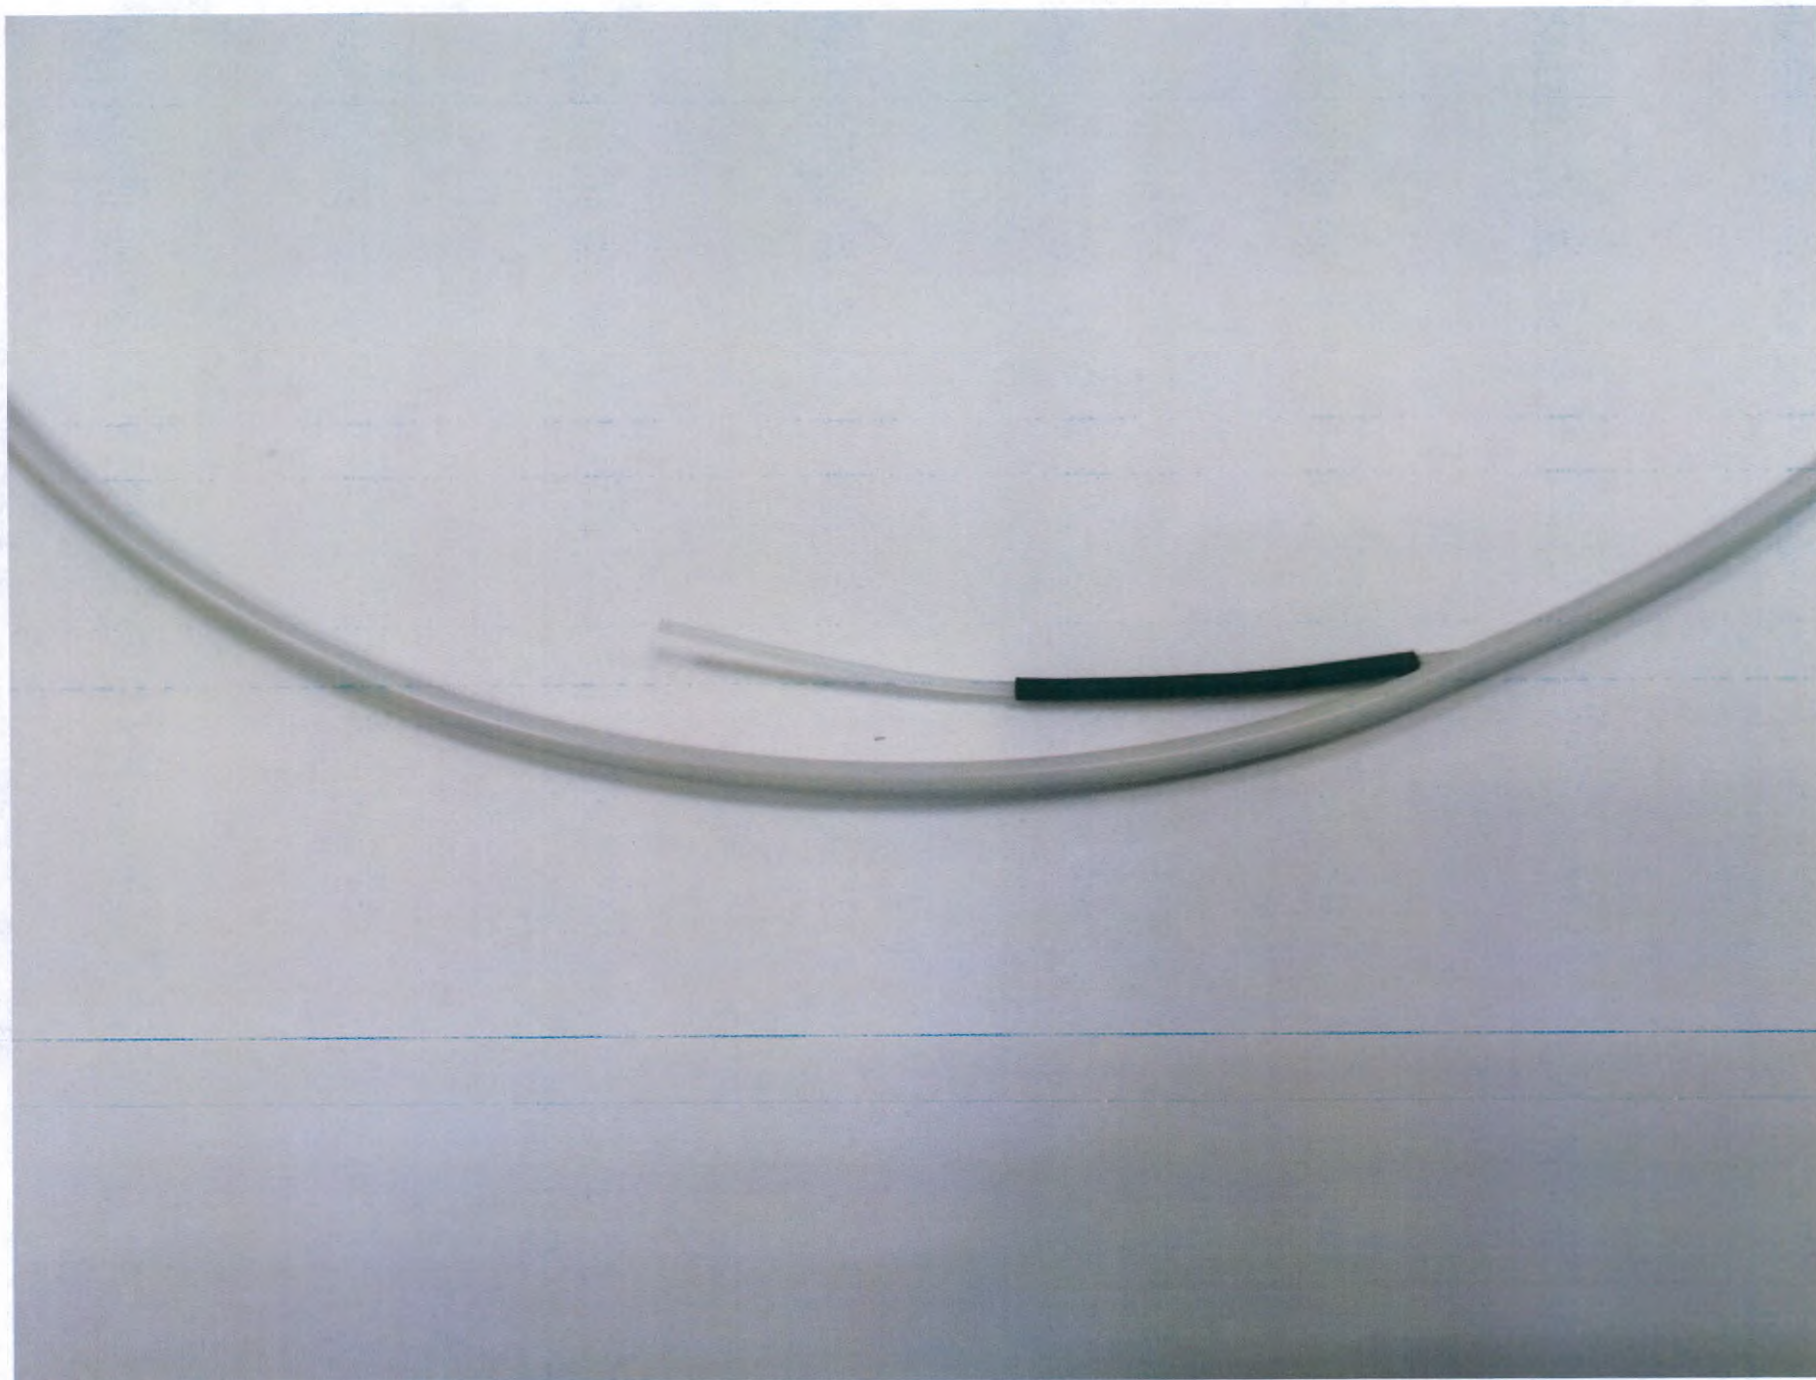


Внешний флажок ramпы

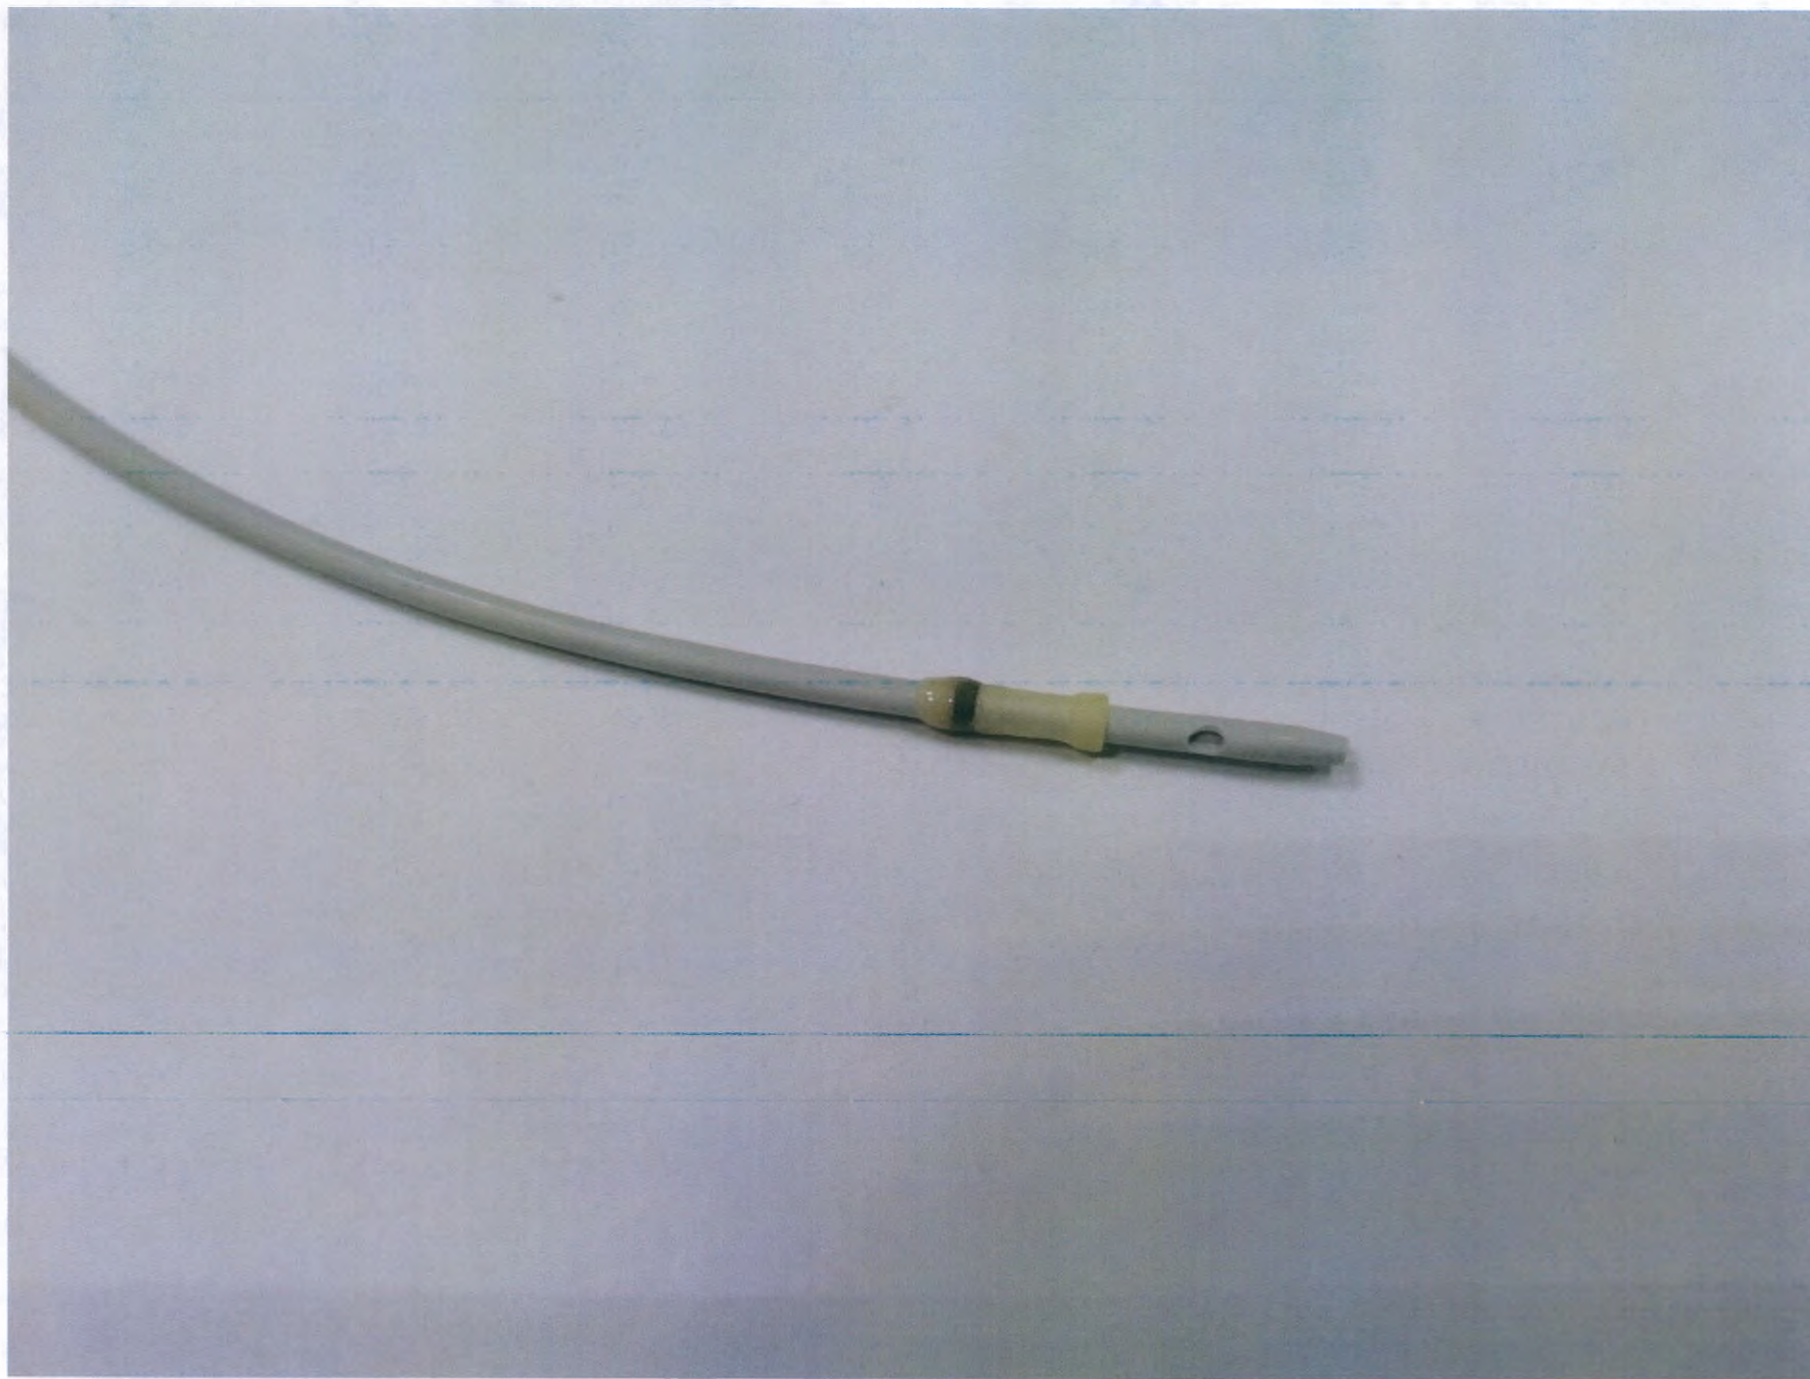

Дистальный конец катетера, баллон (9 мм/12 мм), рентгеноконтрастный маркер, порт для инъекции (выше баллона)

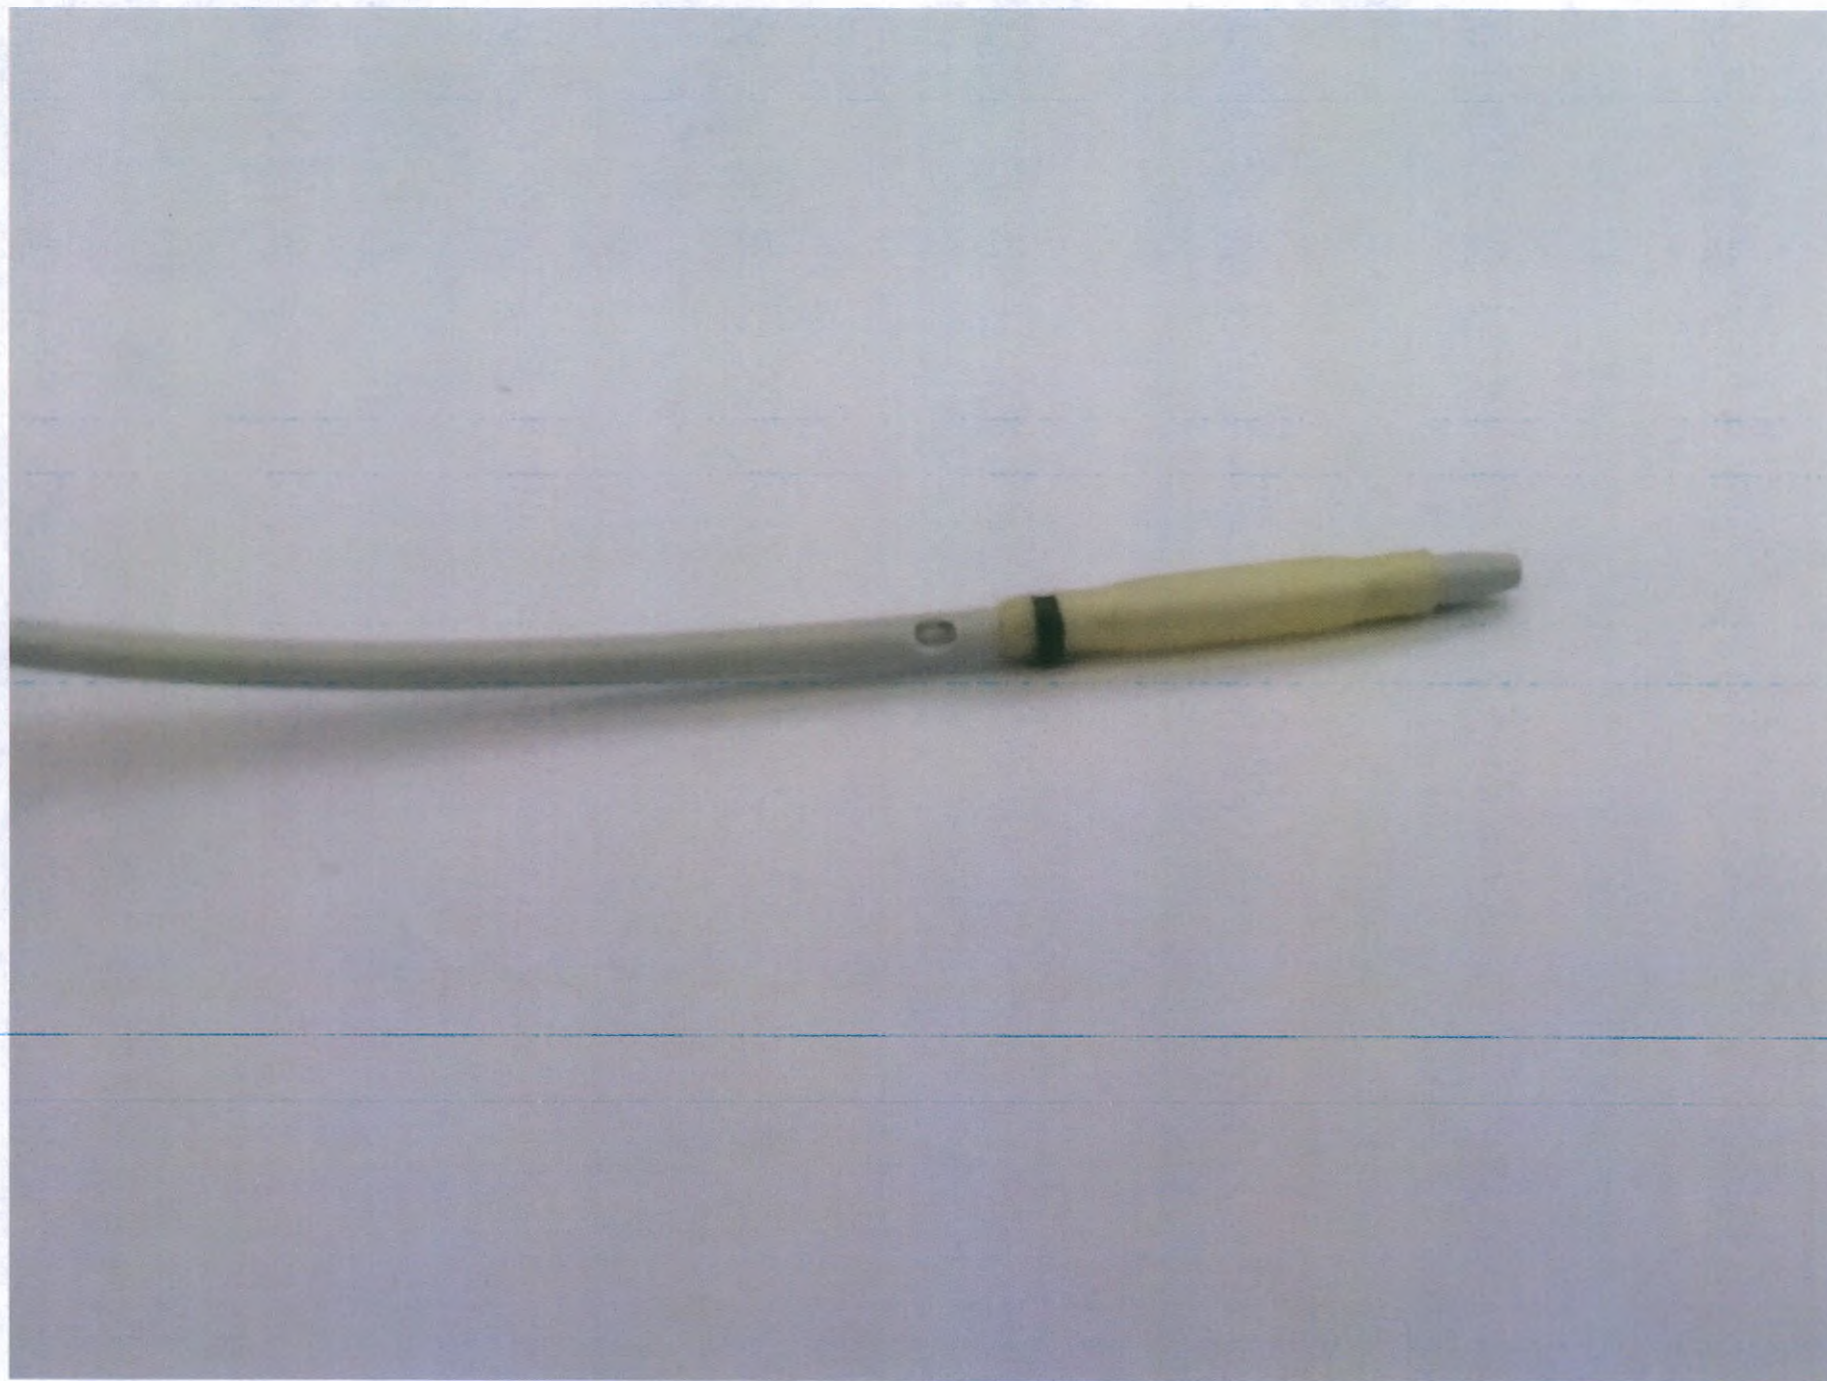

Дистальный конец катетера, баллон (15 мм/18 мм), рентгеноконтрастный маркер, порт для инъекции (ниже баллона)

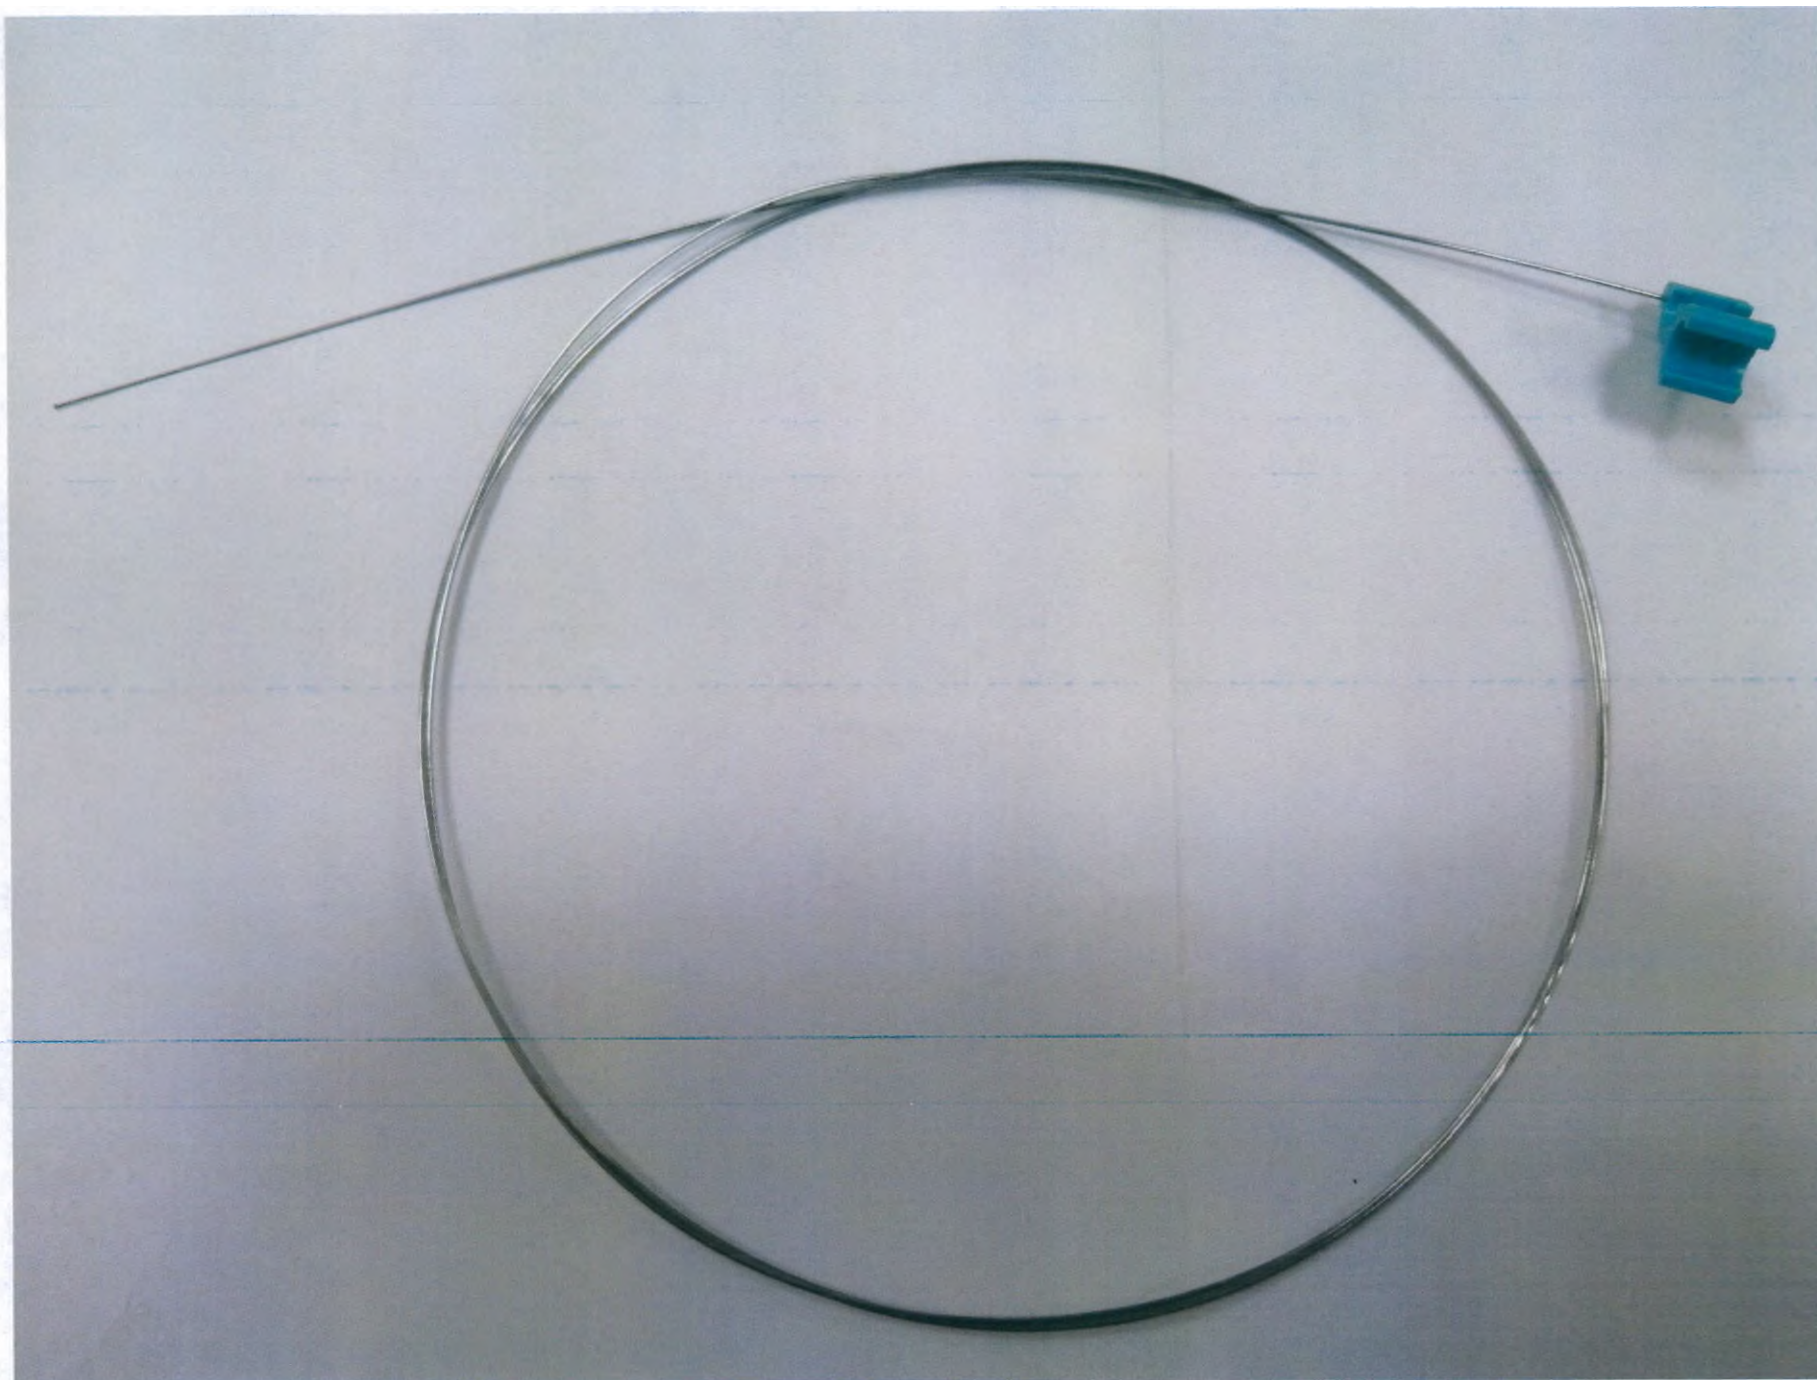

Стилет и зажим стилета

Boston
Scientific

Extractor™ Pro RX

Retrieval Balloon Catheter

Extractor™ Pro RX-S

Retrieval Balloon Catheter

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	7
Mode d'emploi	12
Gebrauchsanweisung	17
Istruzioni per l'uso	23
Gebruiksaanwijzing	28
Instruções de Utilização	33



91070968-01

2015-12

Инструкция по применению (вид спереди)

ARG Argentina
Local Contact

Para obtener información de contacto de Boston Scientific Argentina SA, por favor, acceda al link www.bostonscientific.com/arg

BRA Brazil
Local Contact

Para informações de contato da Boston Scientific do Brasil Ltda, por favor, acesse o link www.bostonscientific.com/bra

EC REP EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

AUS Australian
Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

 Legal
Manufacturer


Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001

 Do not use if package
is damaged.


 Recyclable
Package

CE 0344


© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

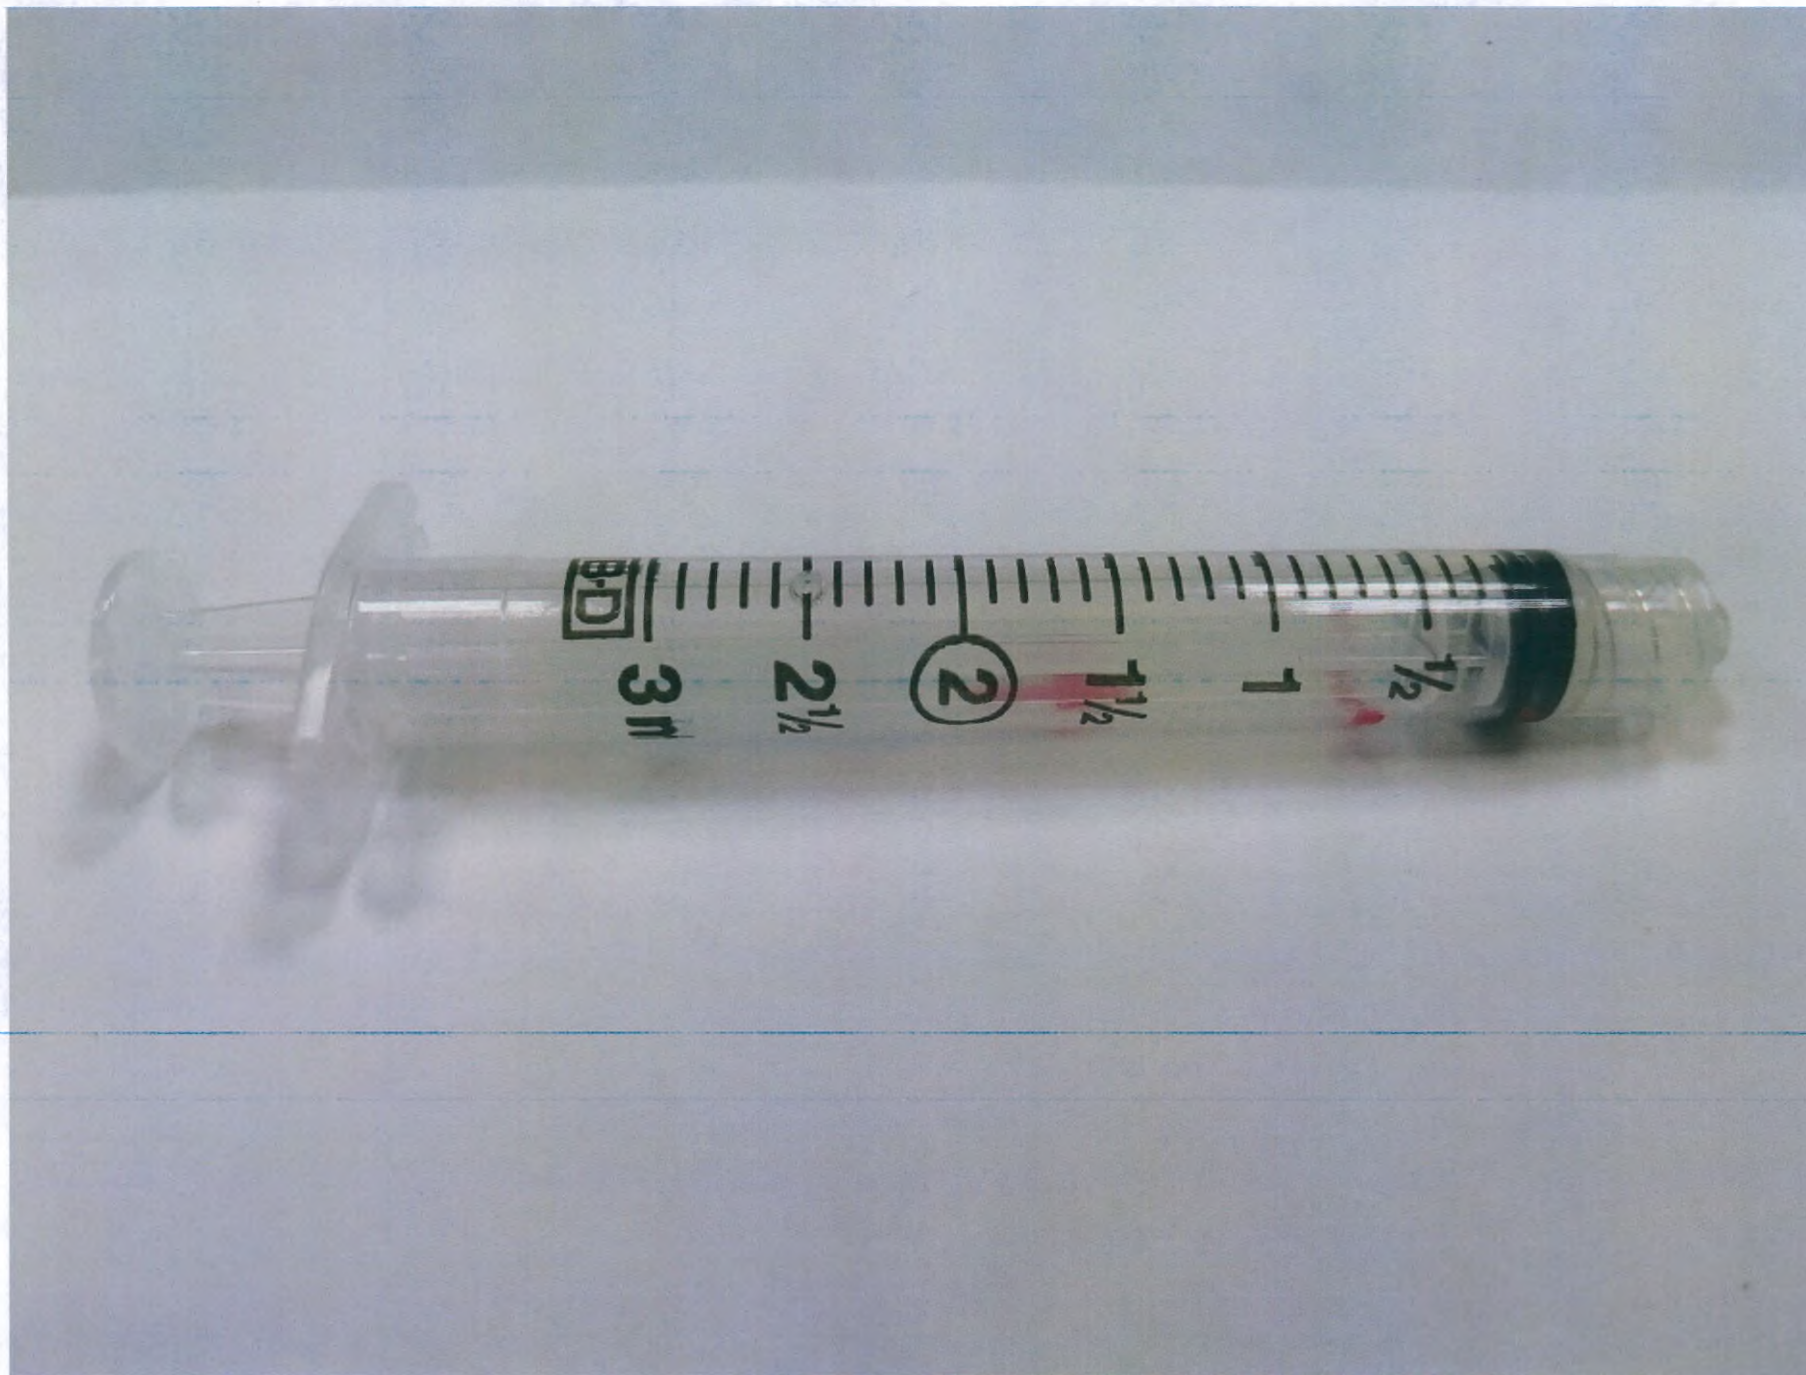


Шприц объемом 3 мл (вид справа)

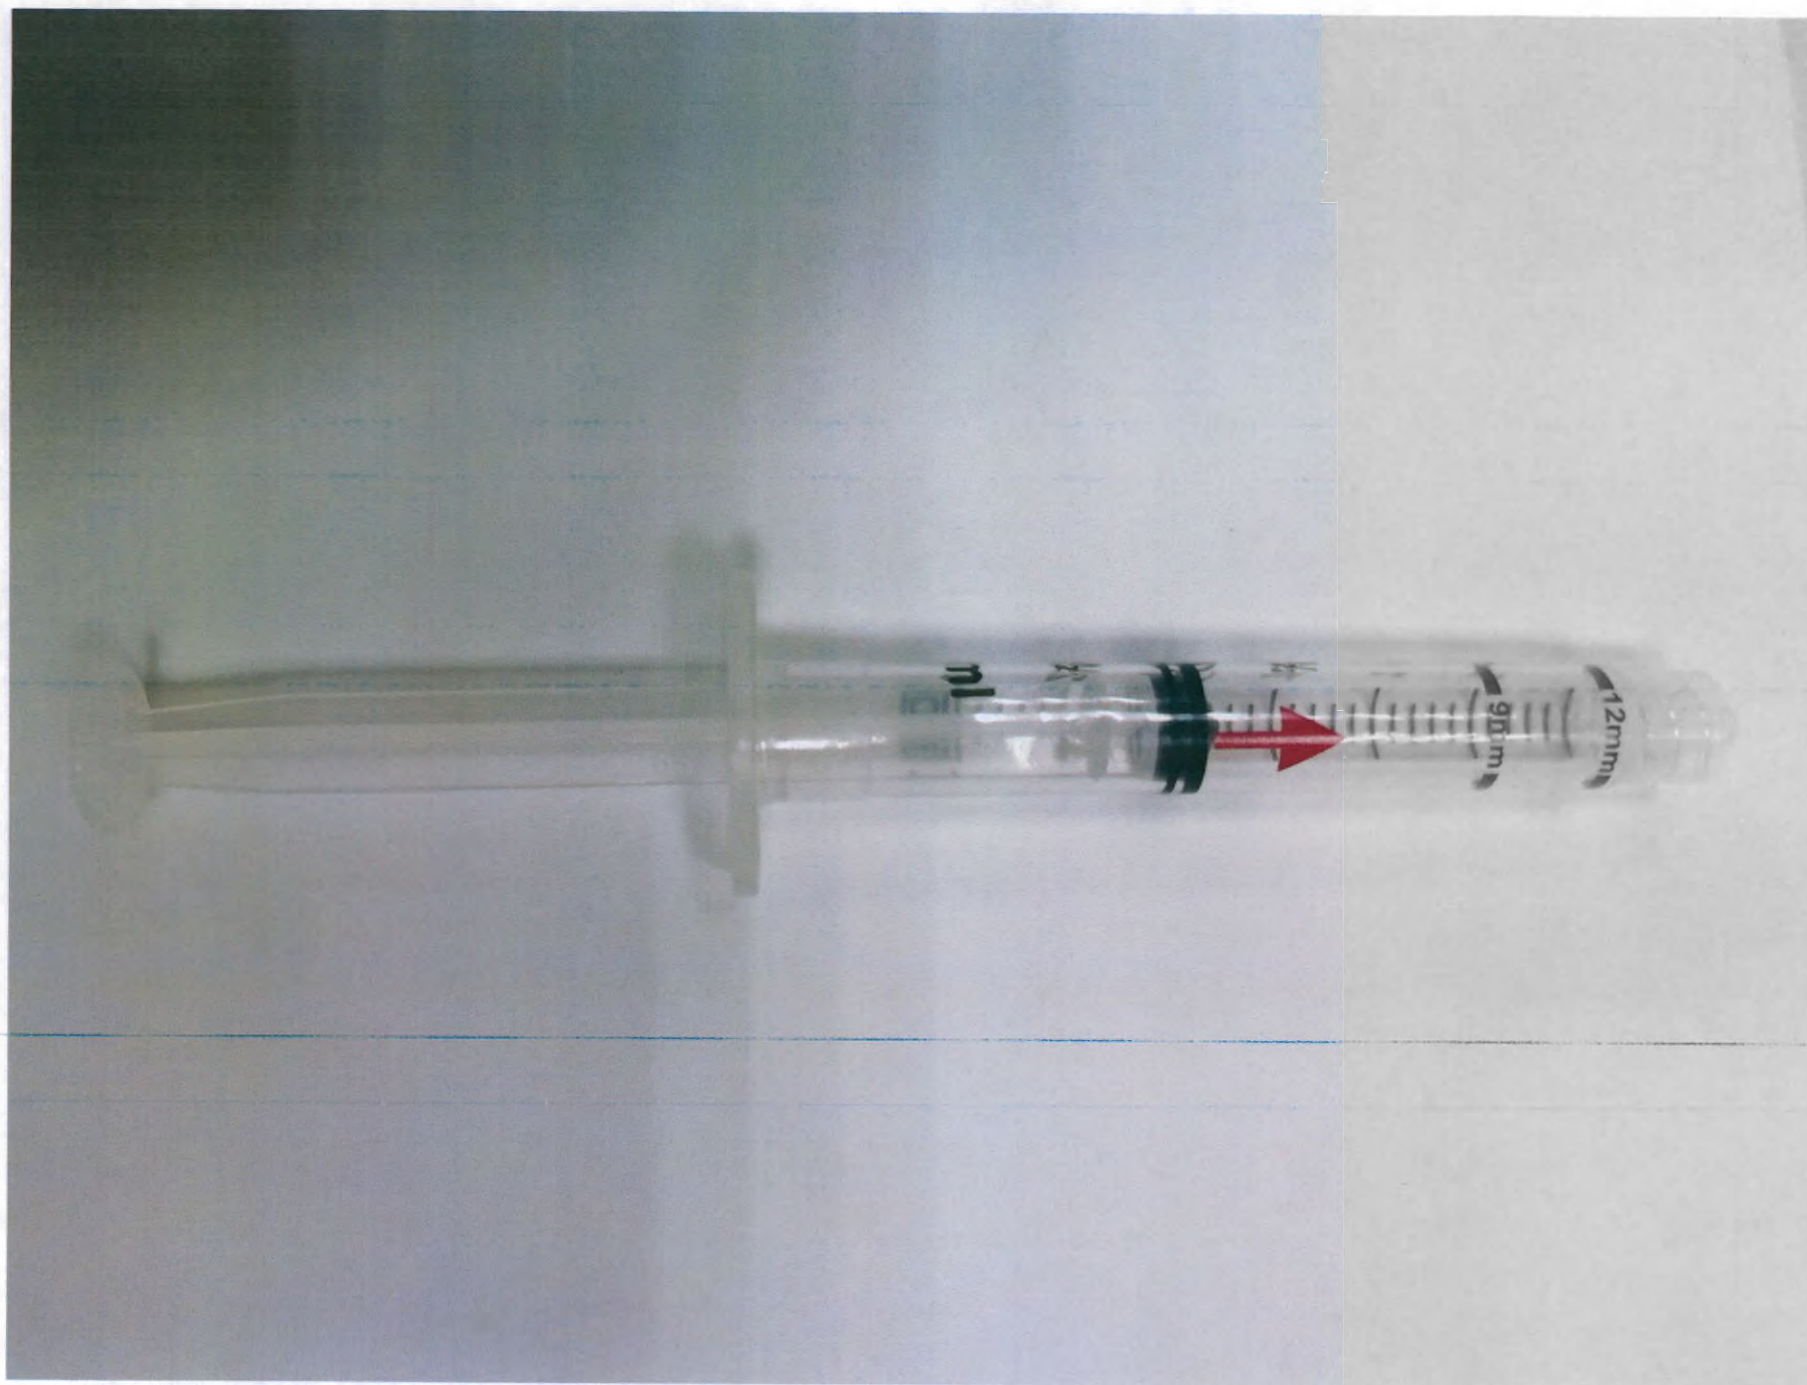


Шприц объемом 3 мл (вид сзади)

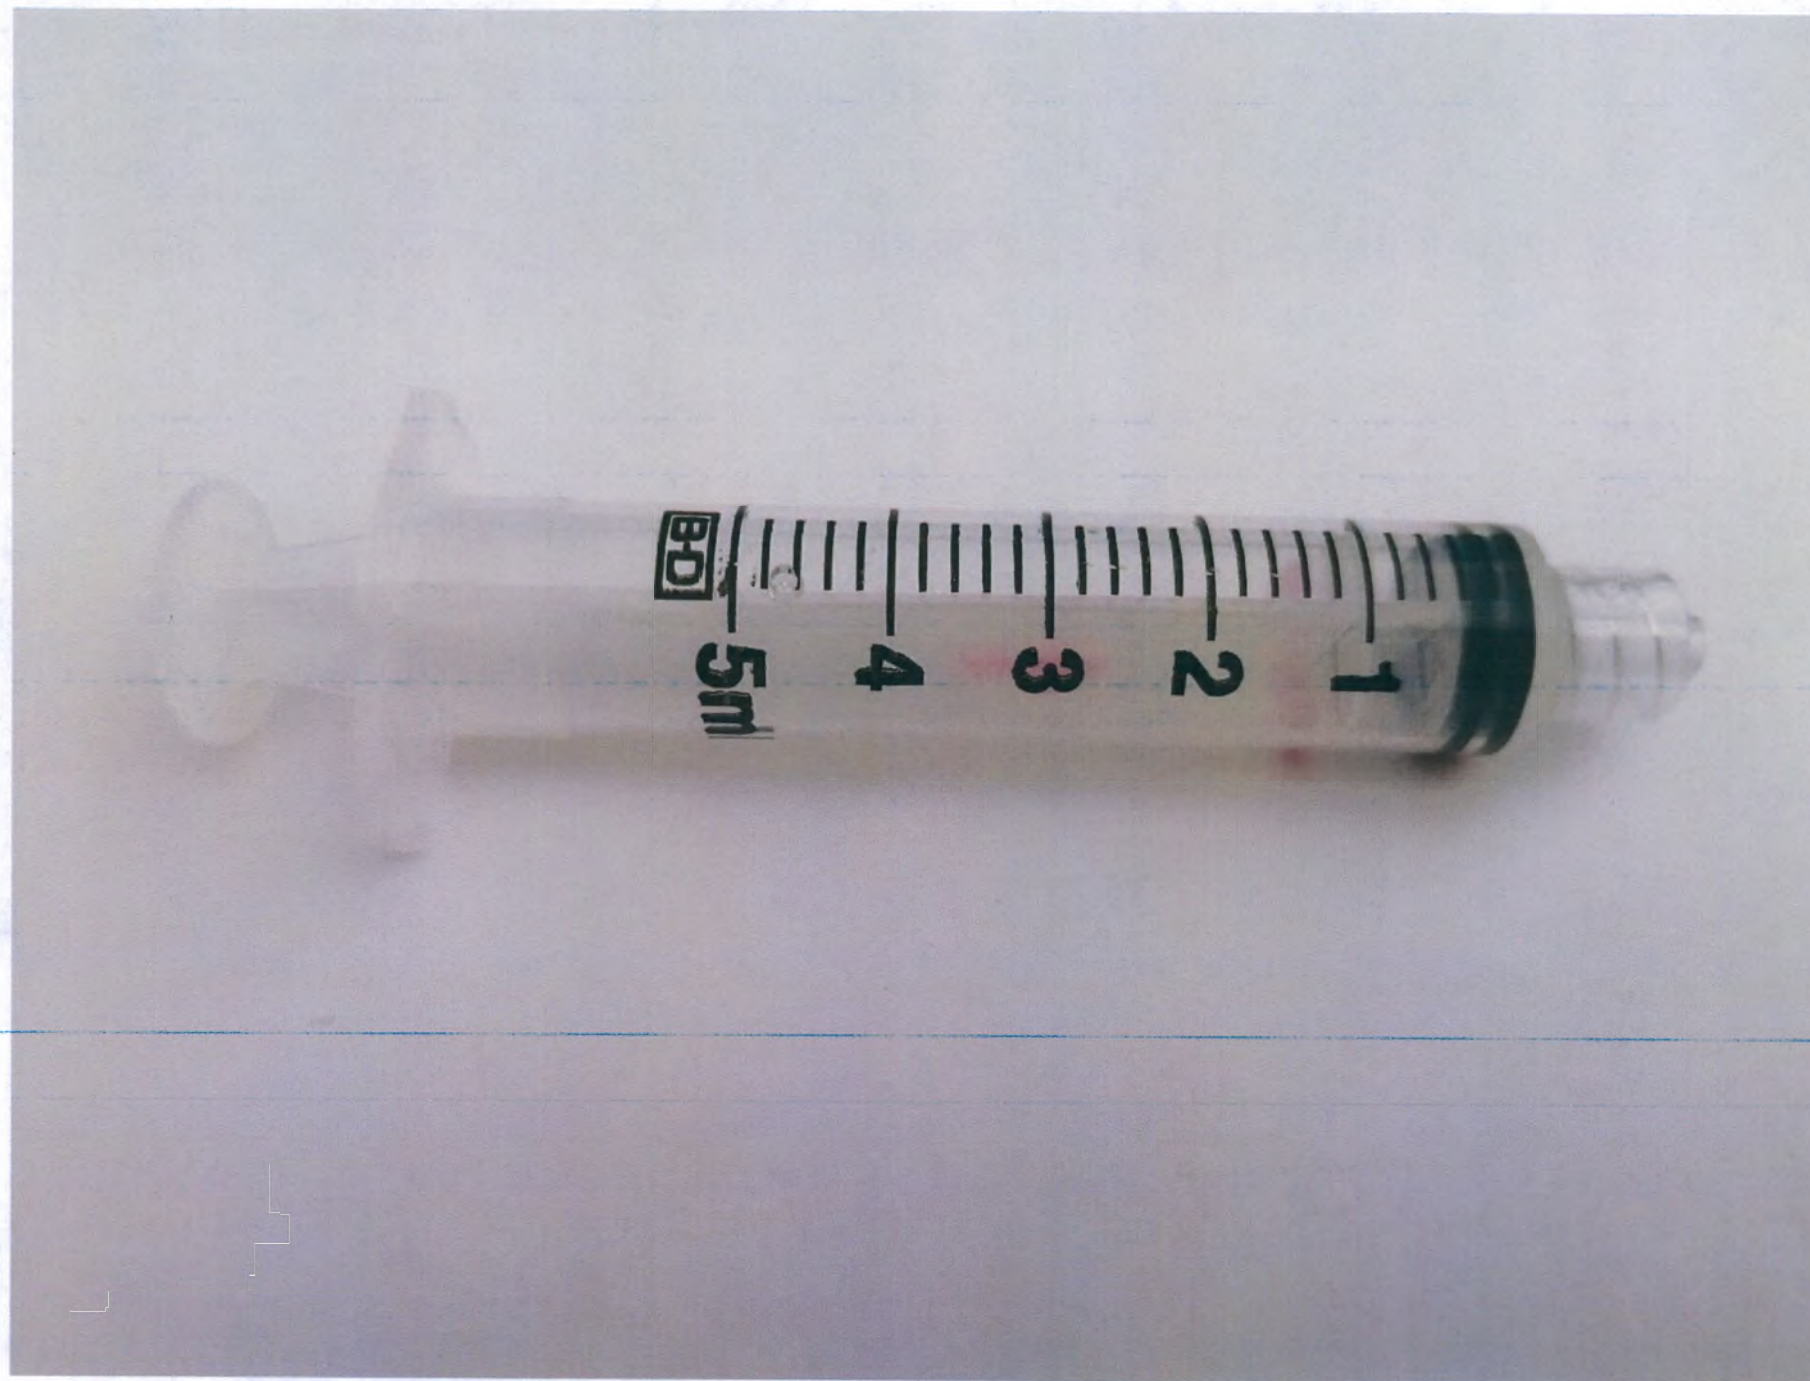


Шприц объемом 5 мл (вид справа)

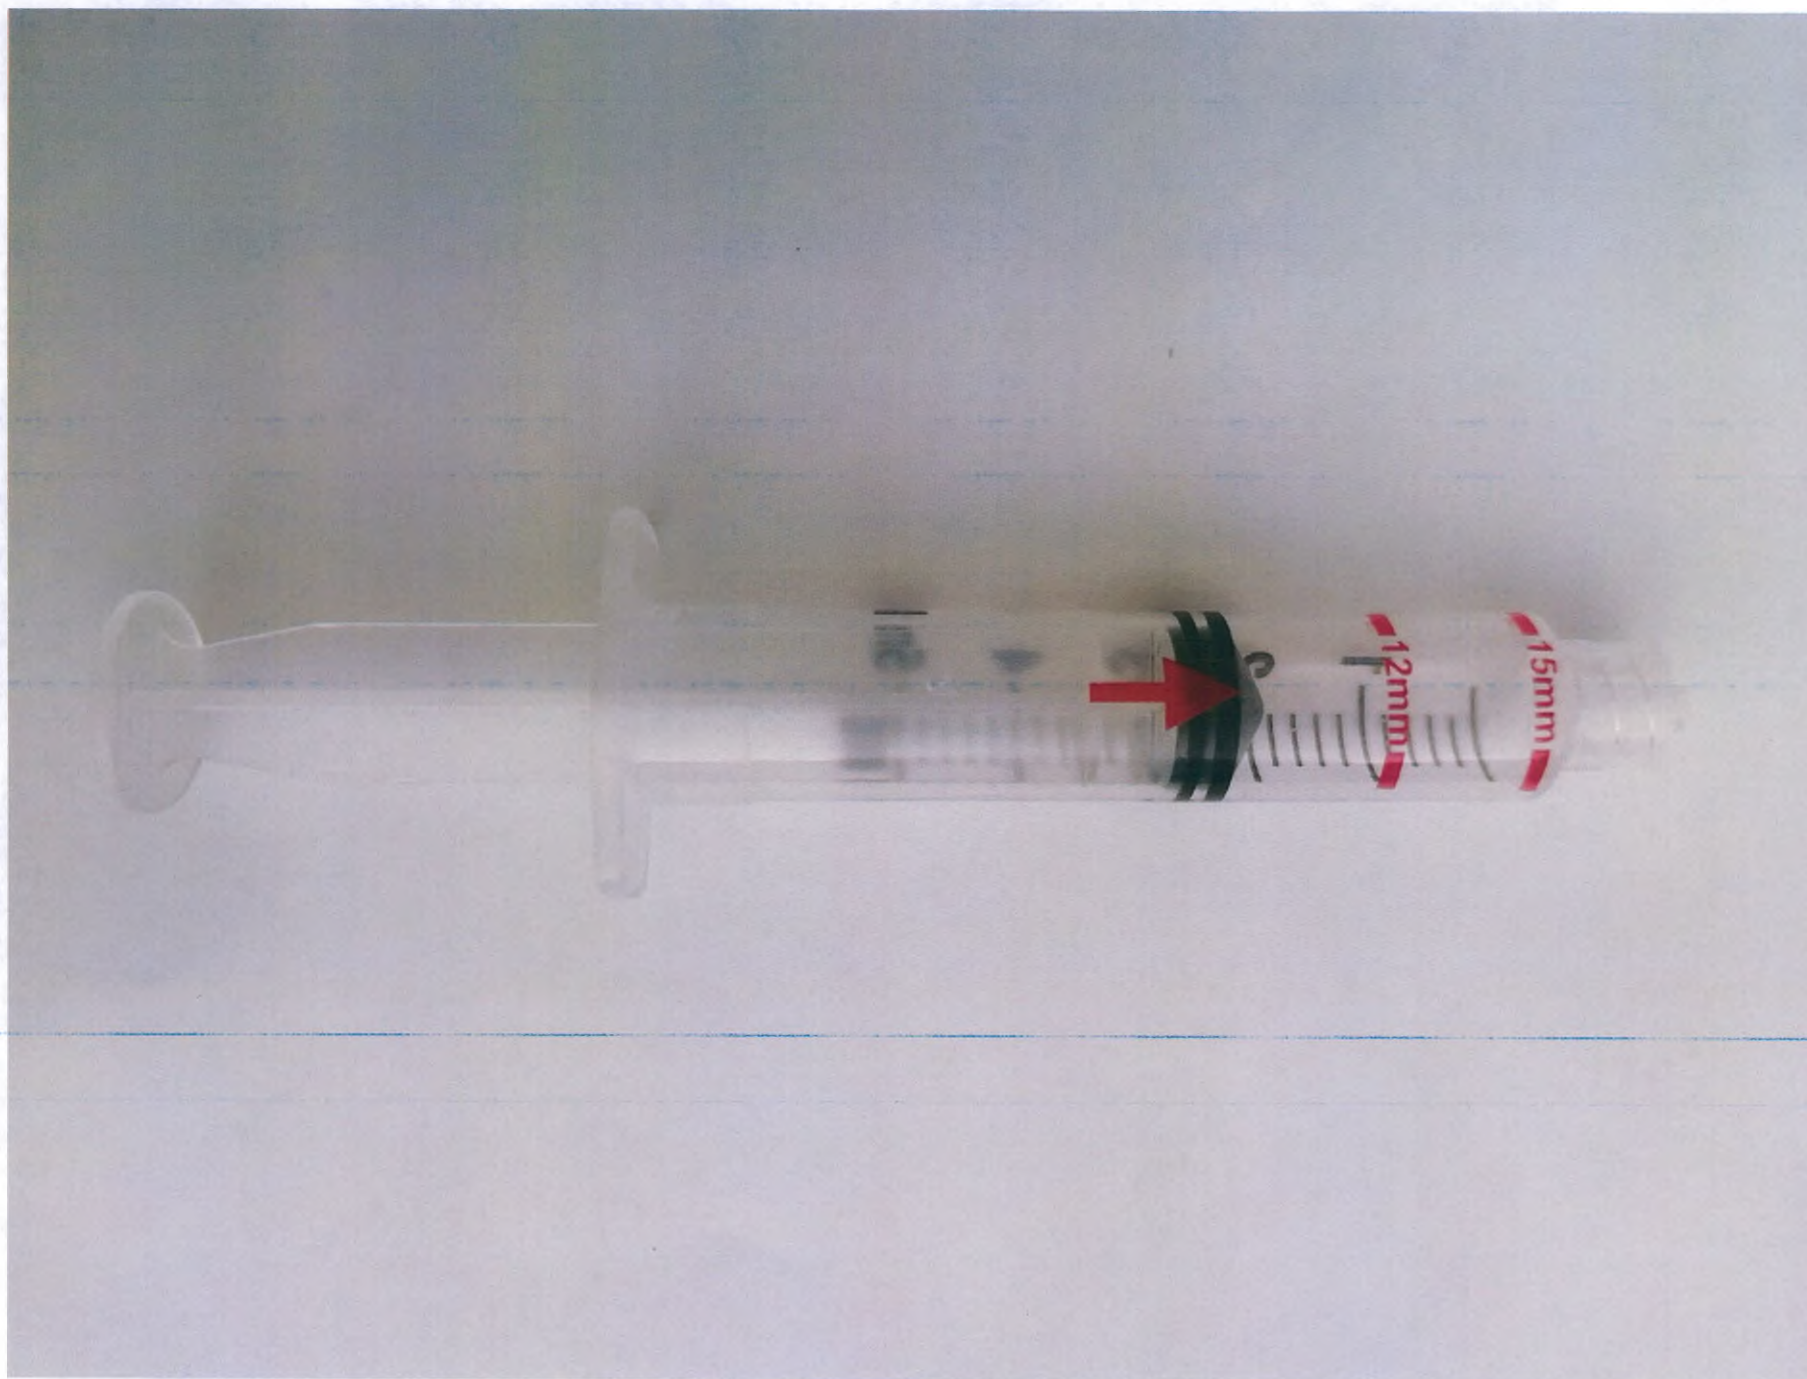


Шприц объемом 5 мл (вид сзади)

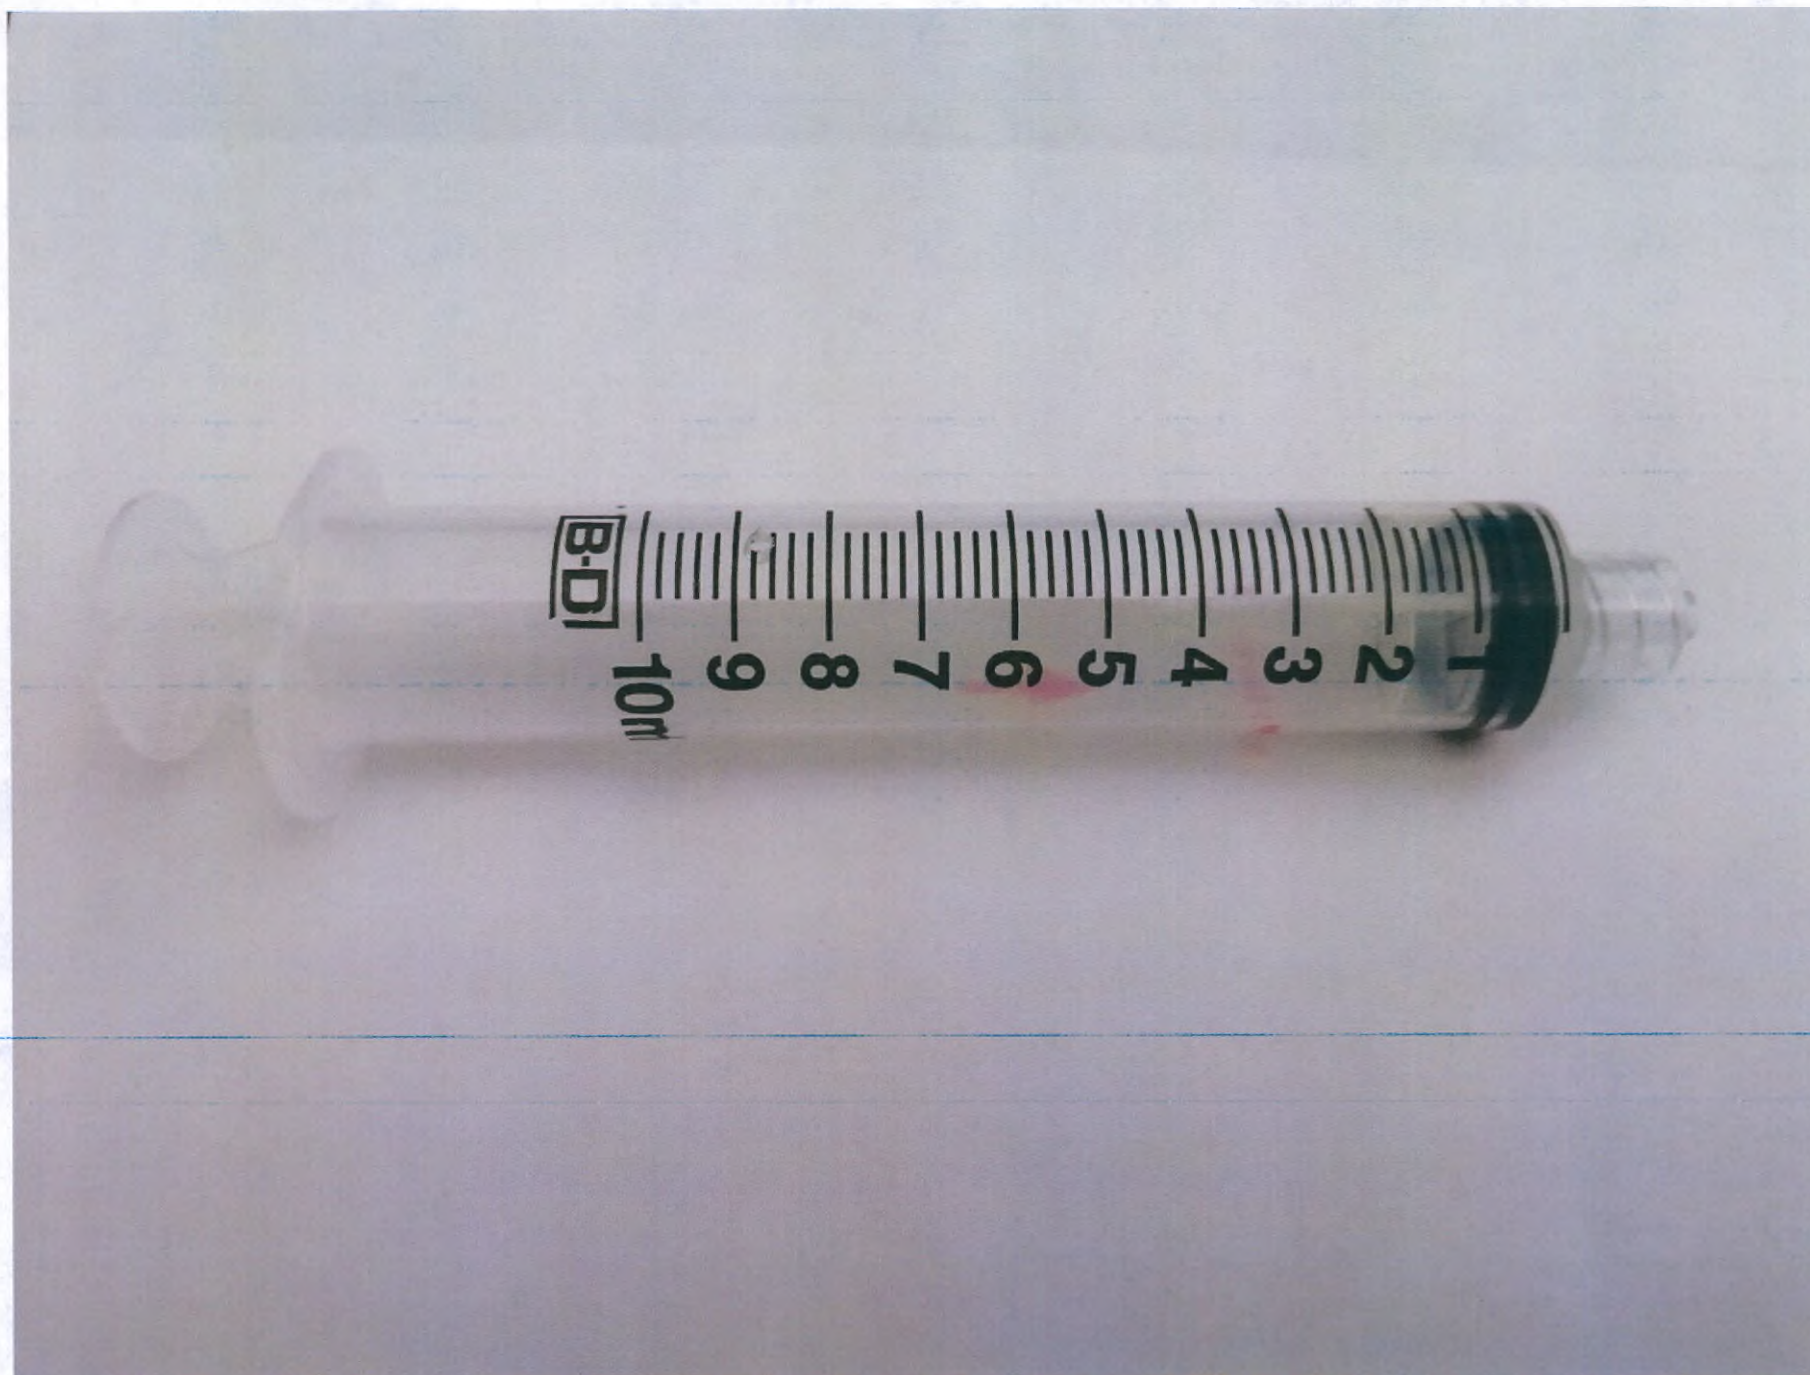


Шприц объемом 10 мл (вид справа)

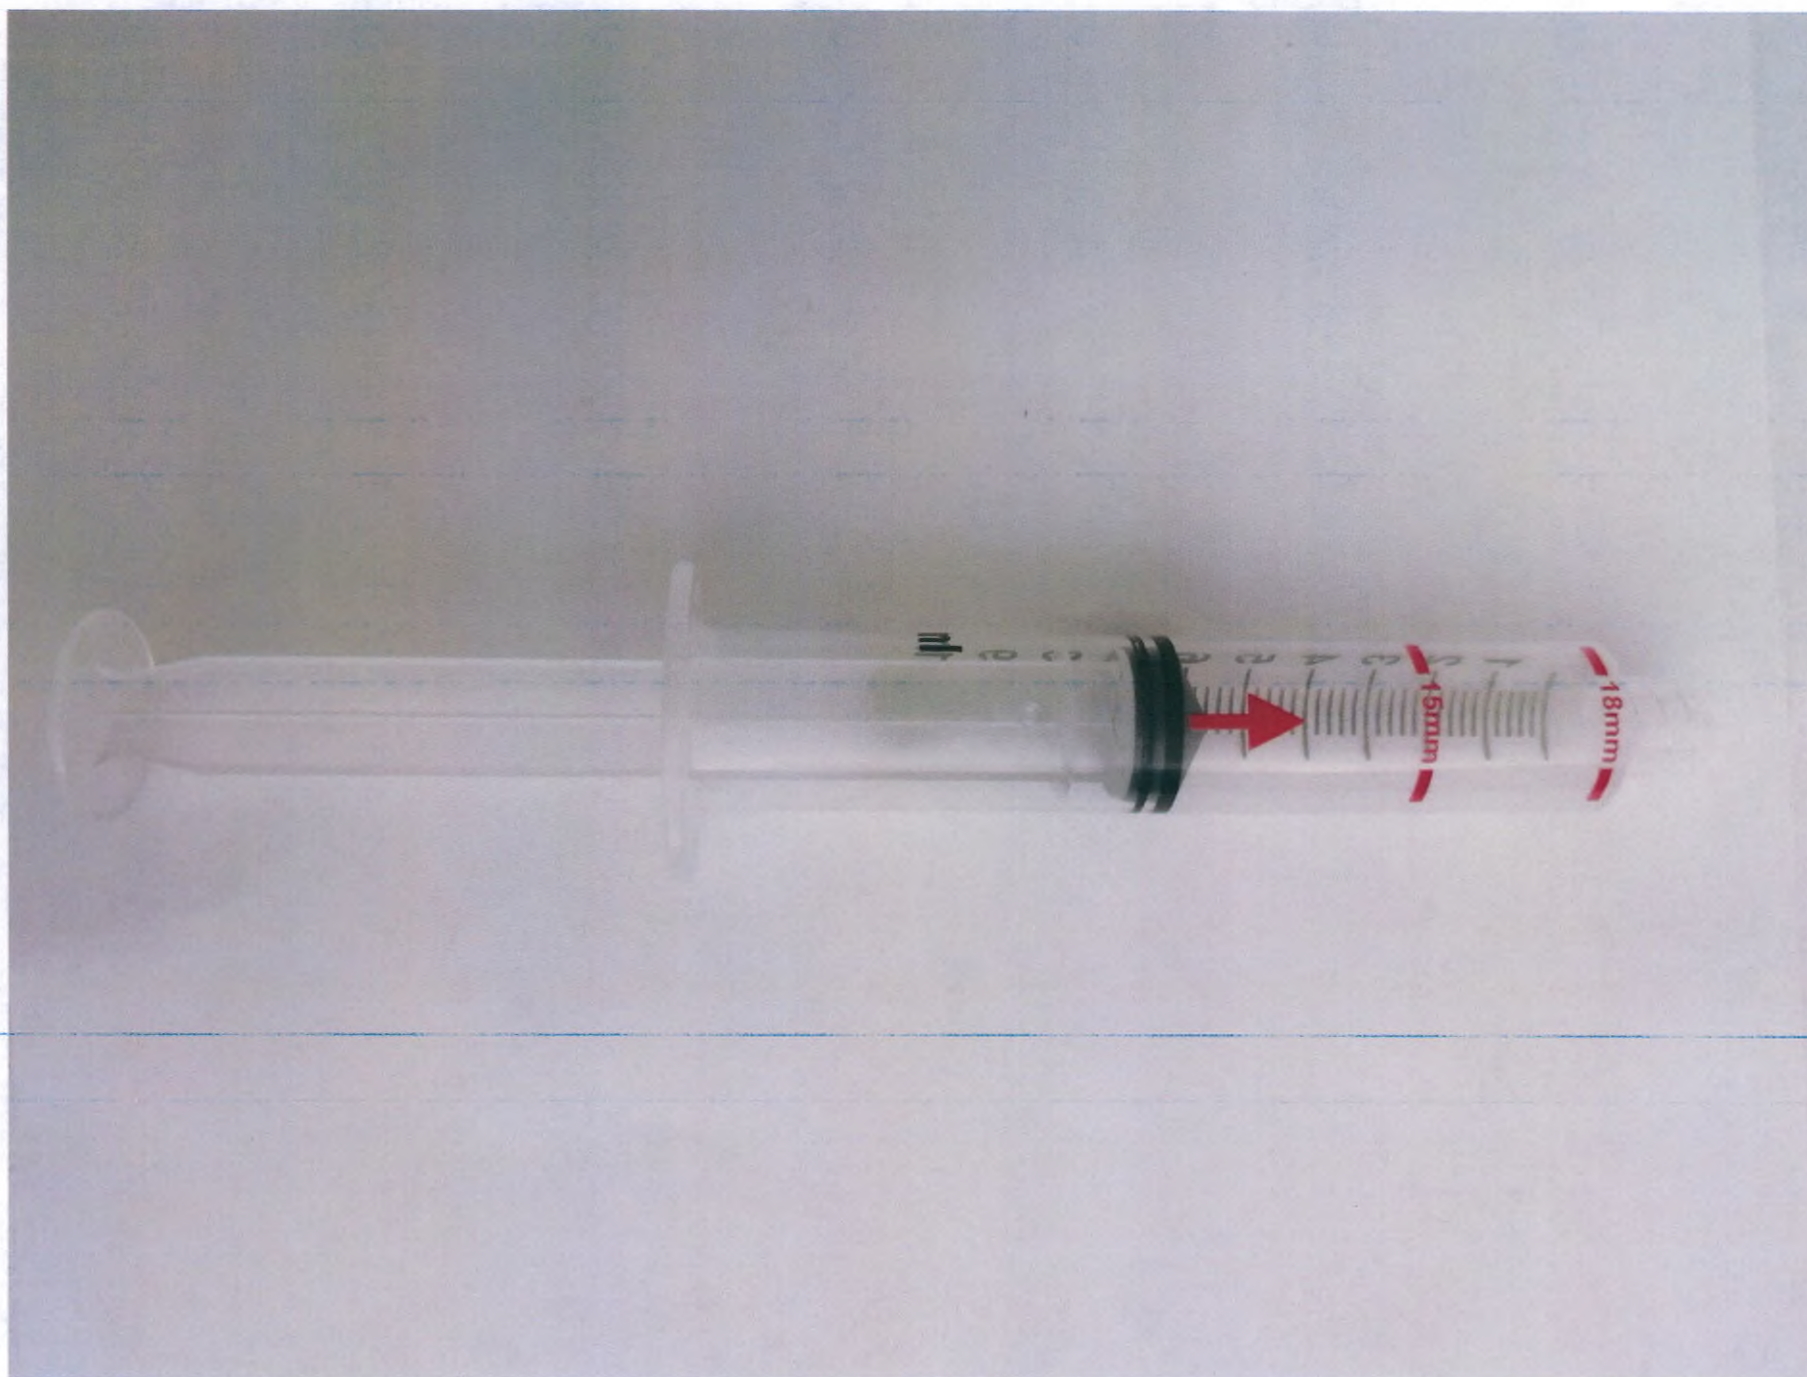


Шприц объемом 10 мл (вид сзади)

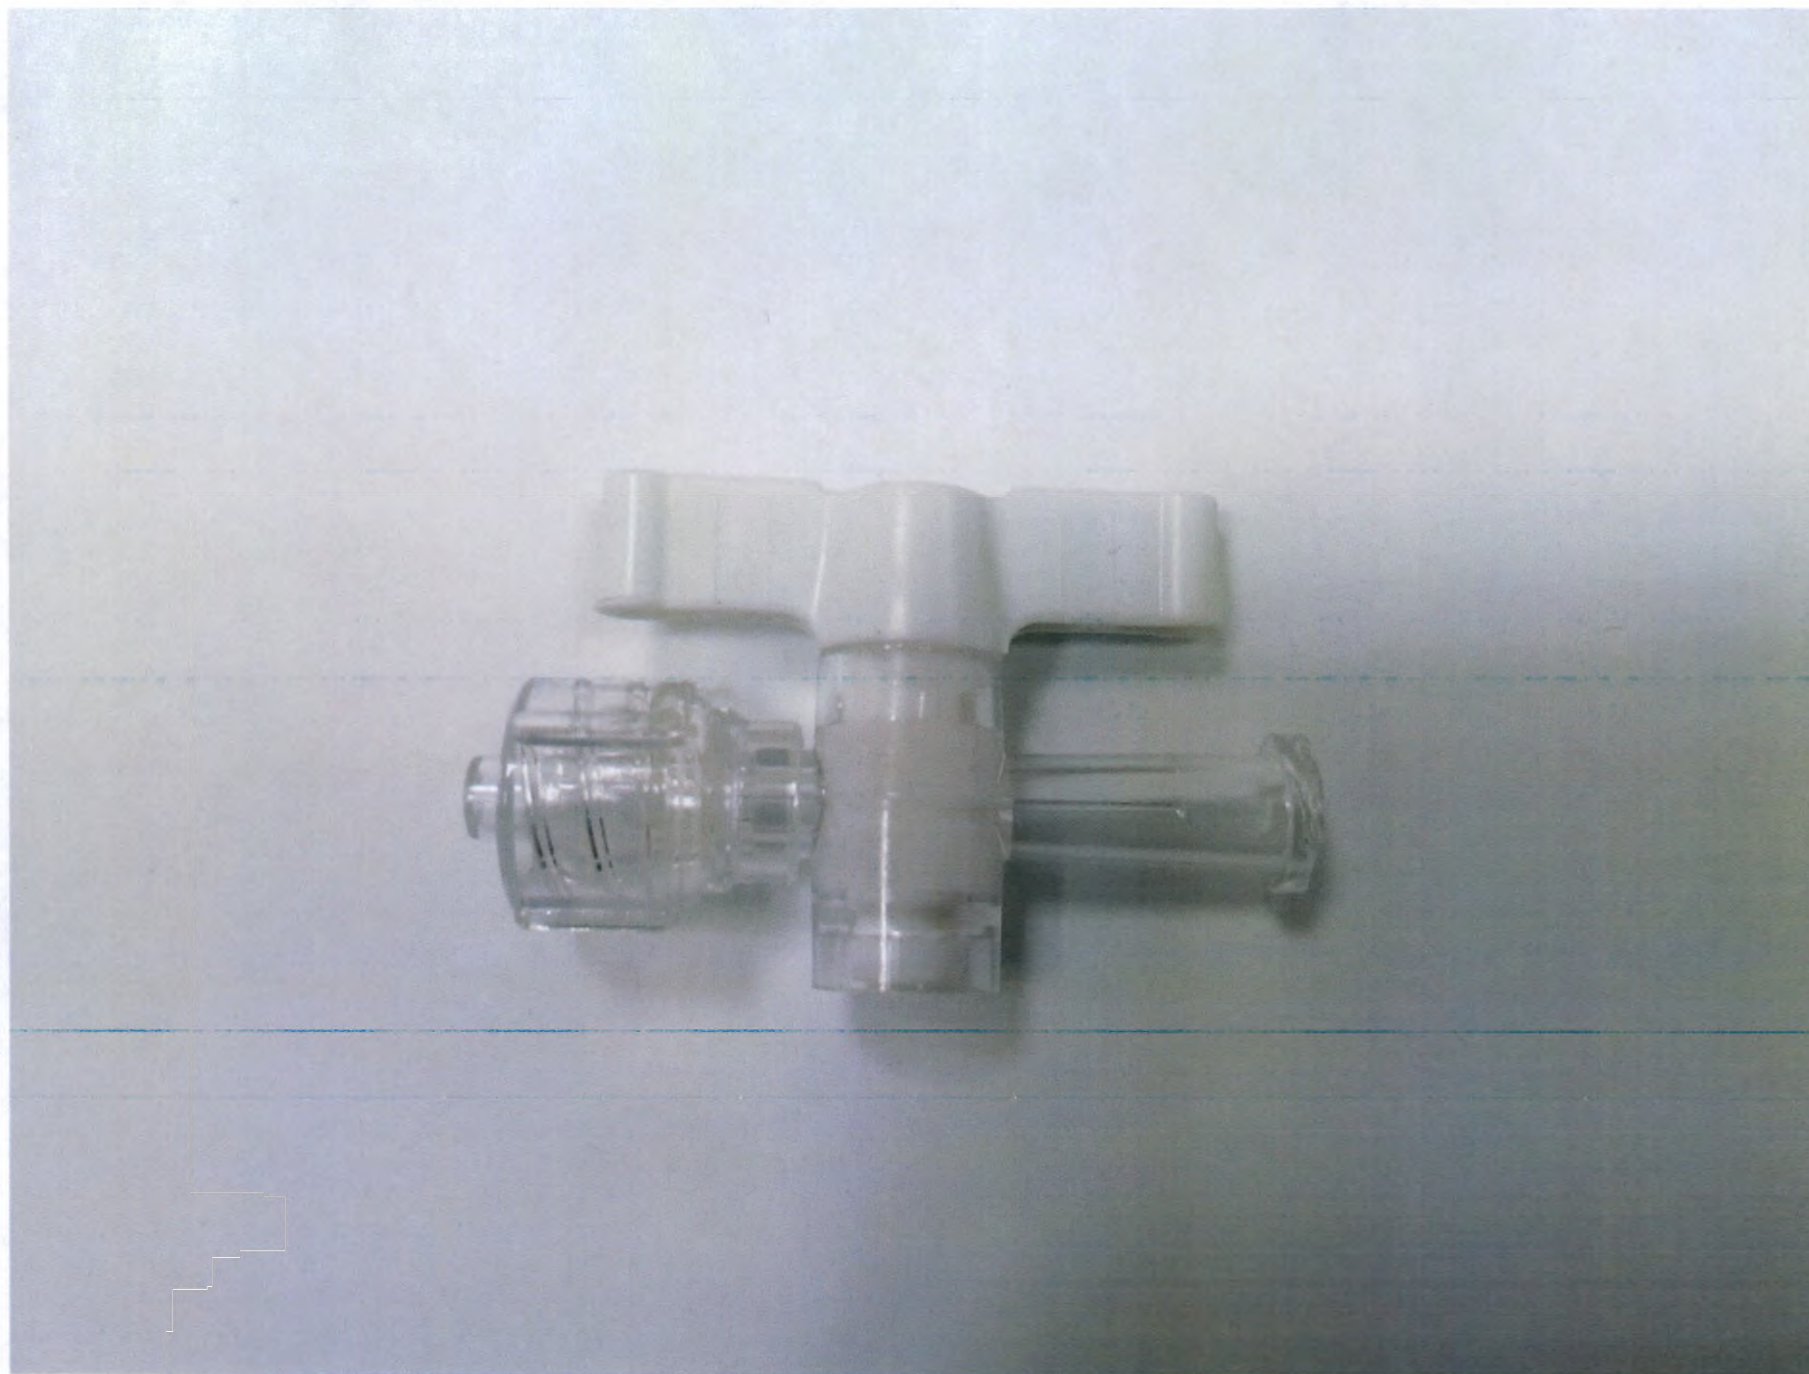


Кран запорный (вид спереди)

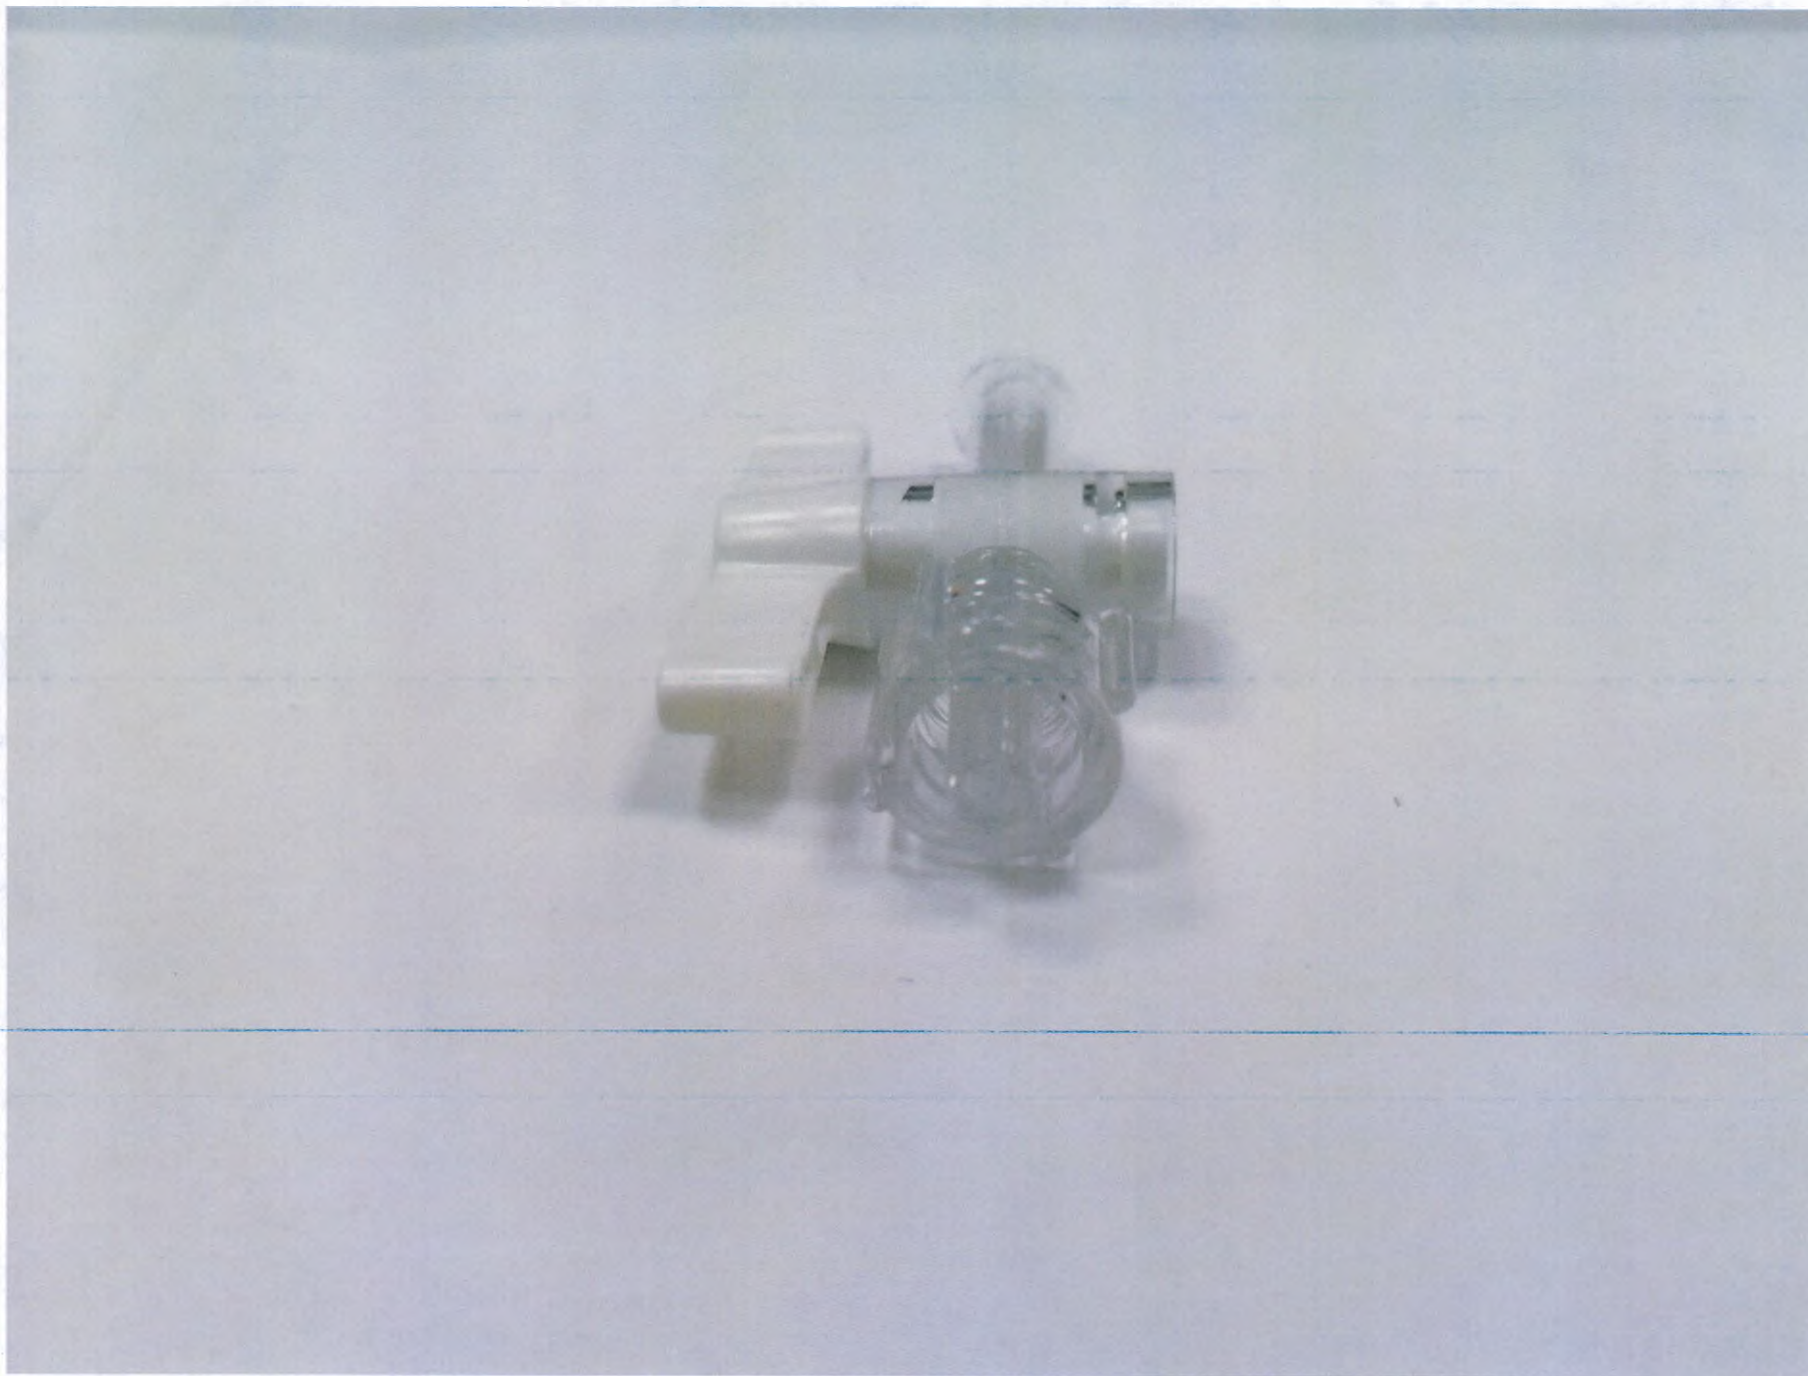


Кран запорный (вид слева)

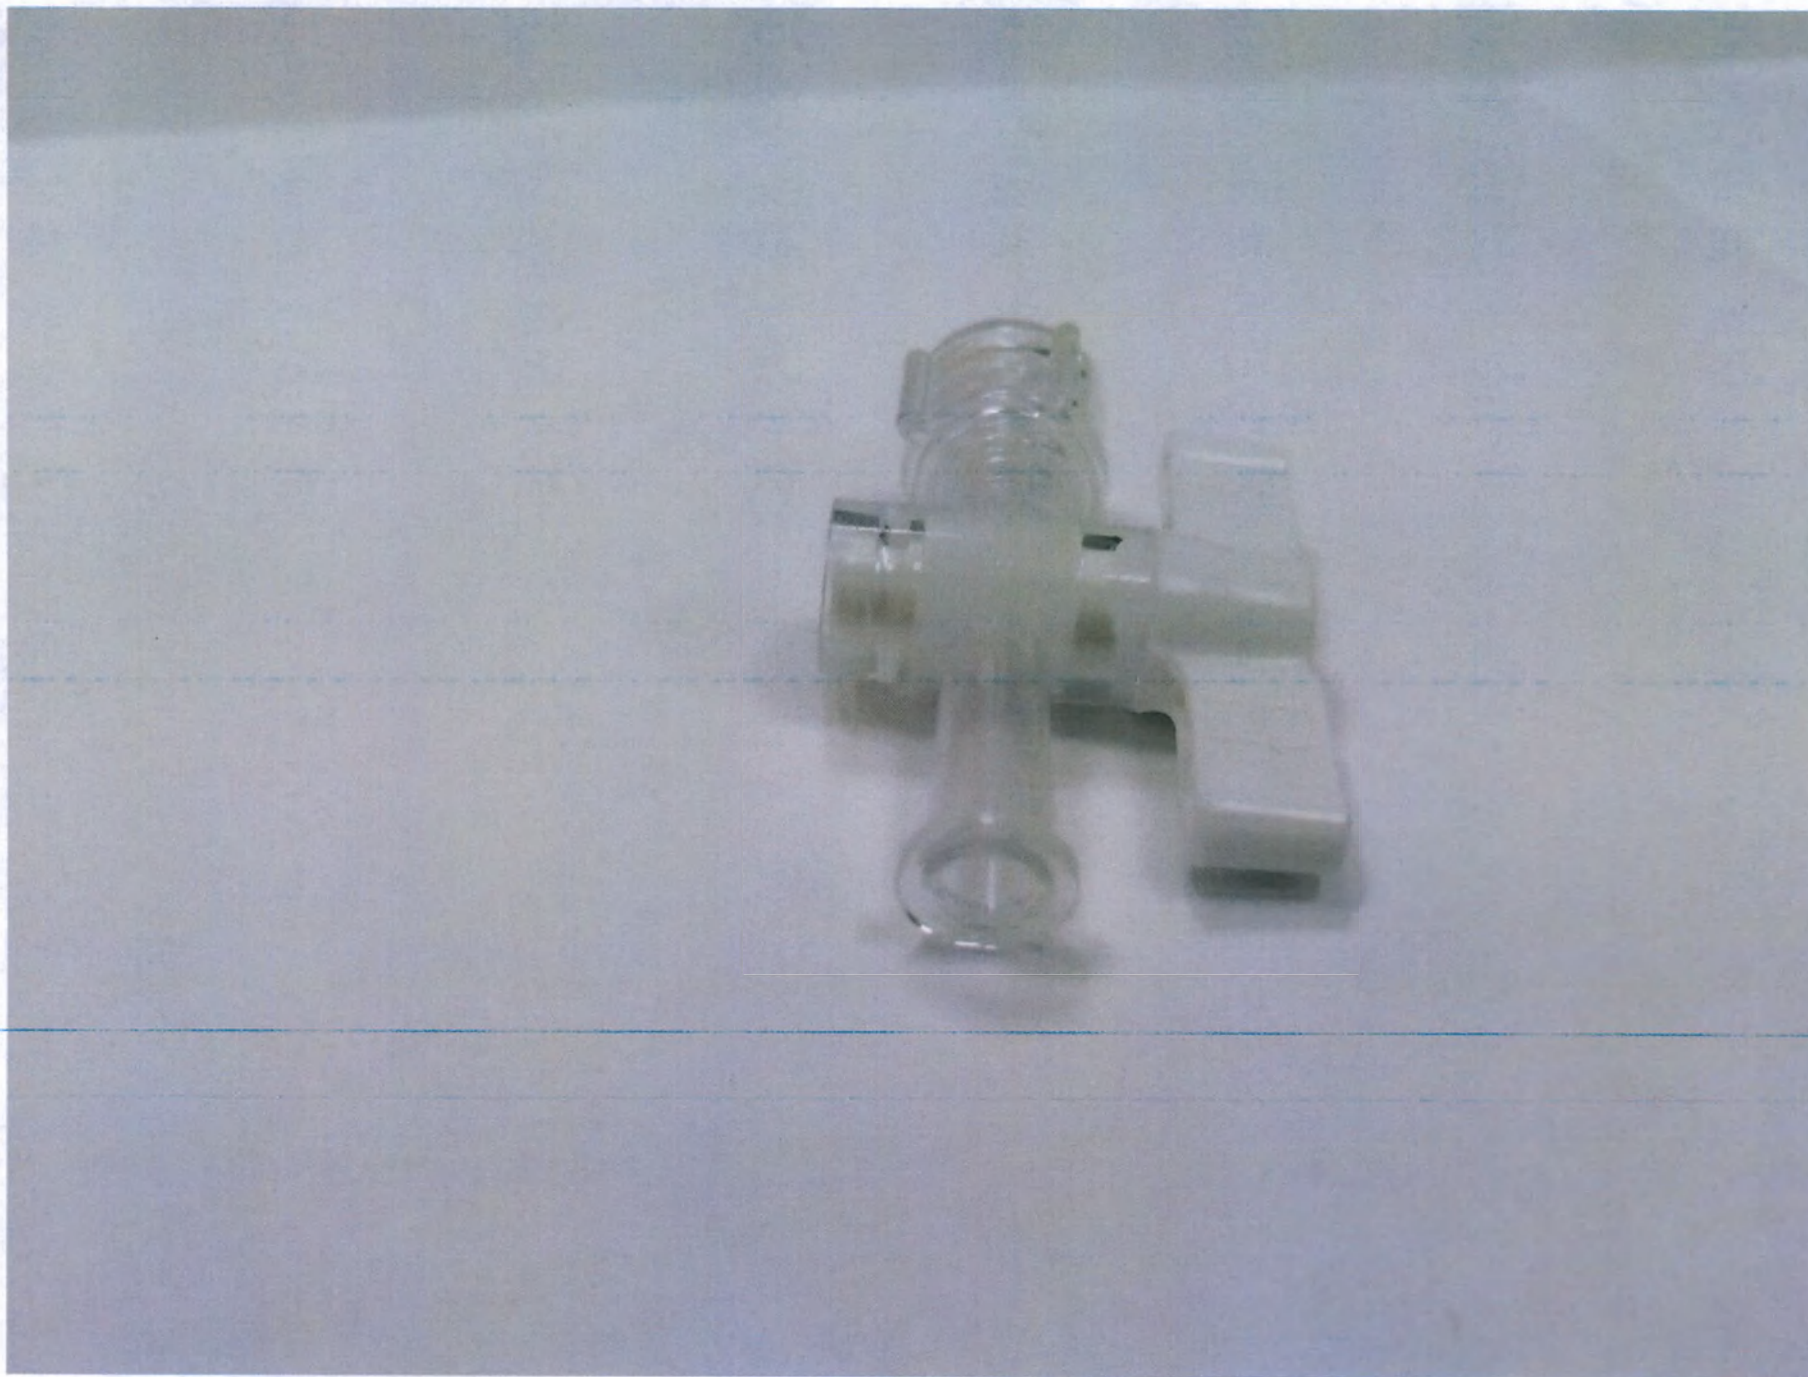

Кран запорный (вид справа)

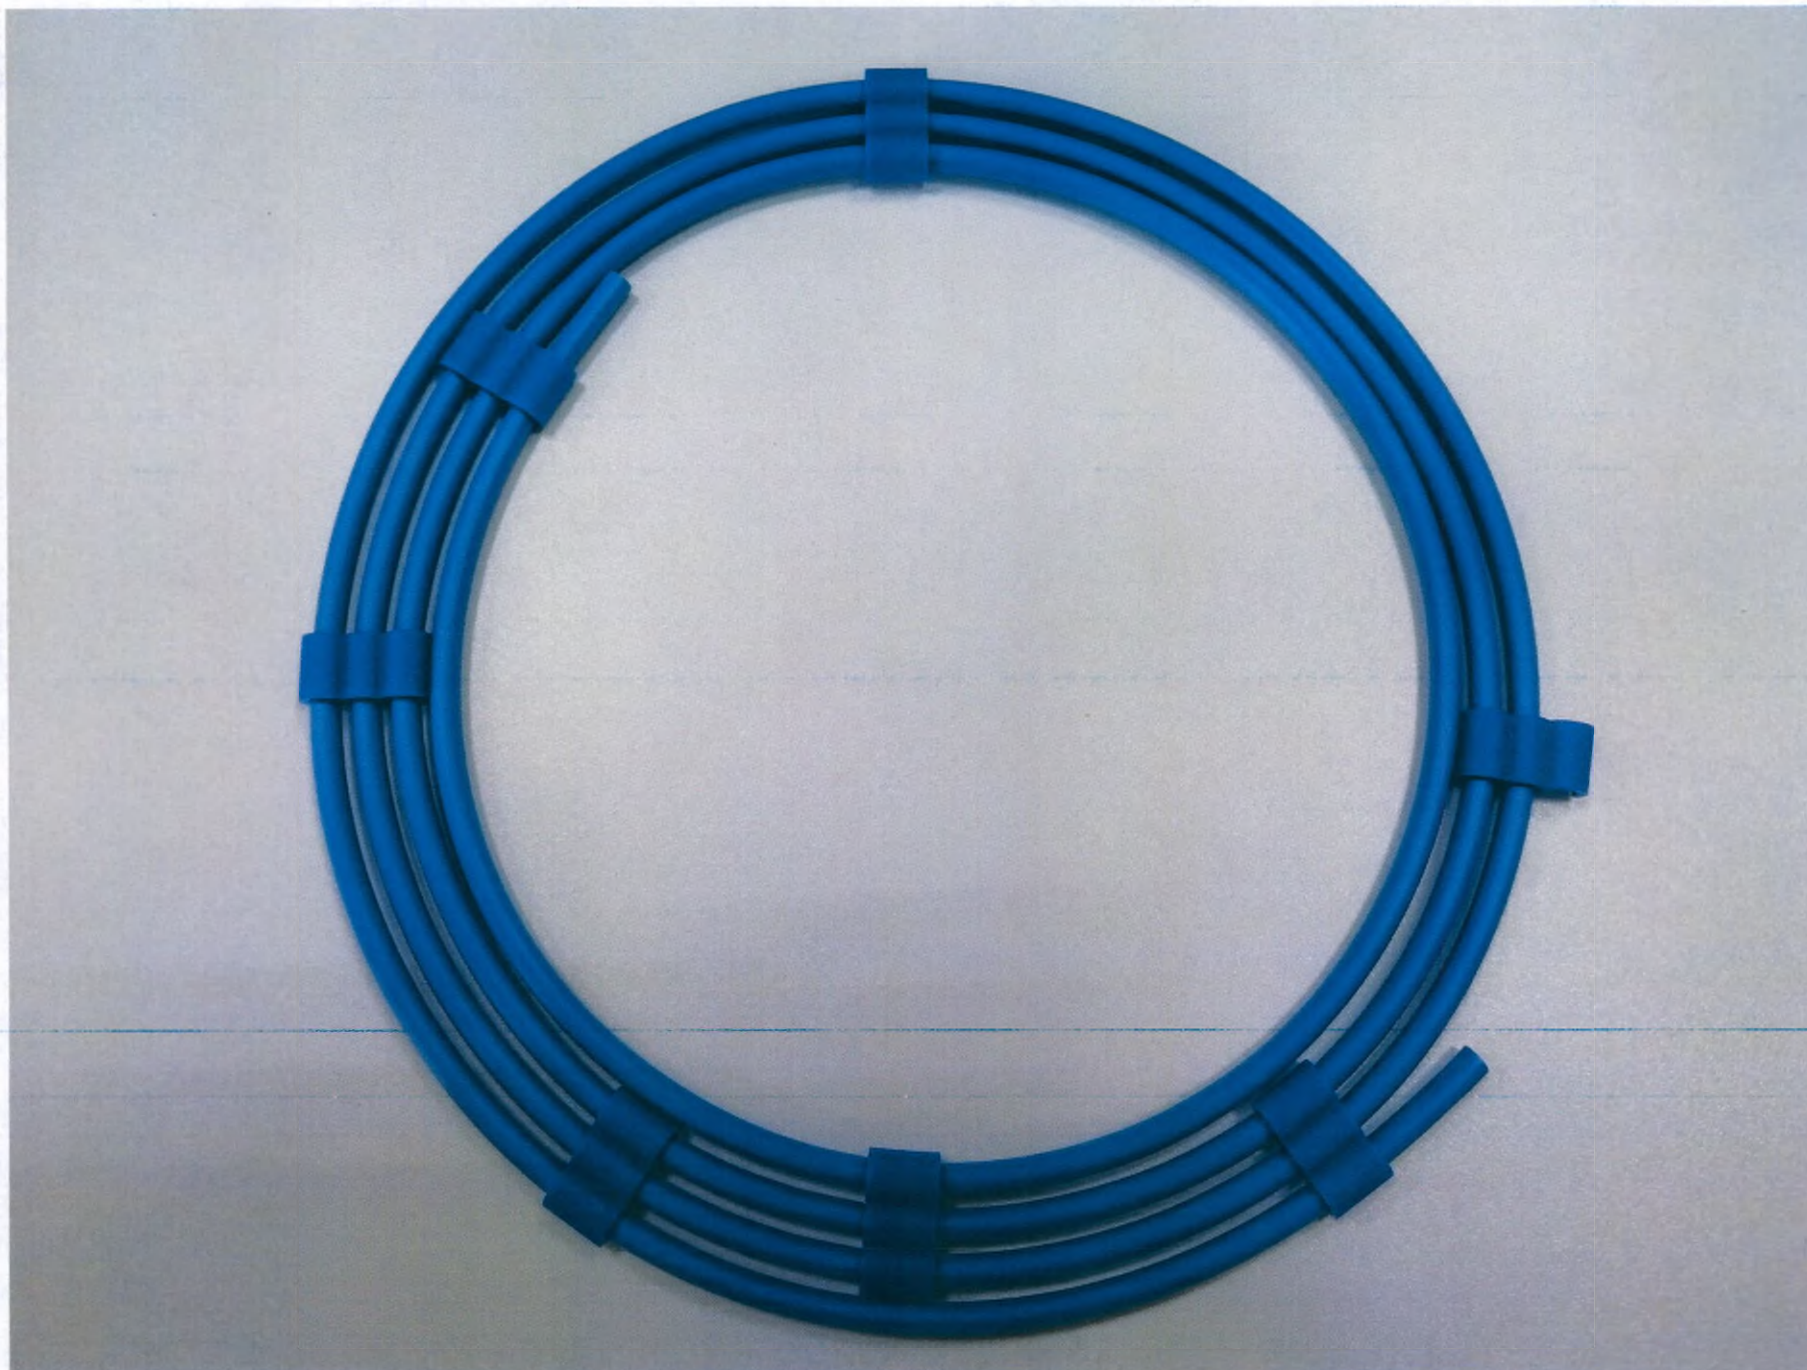

Защитная трубка с зажимами для крепления защитной трубки

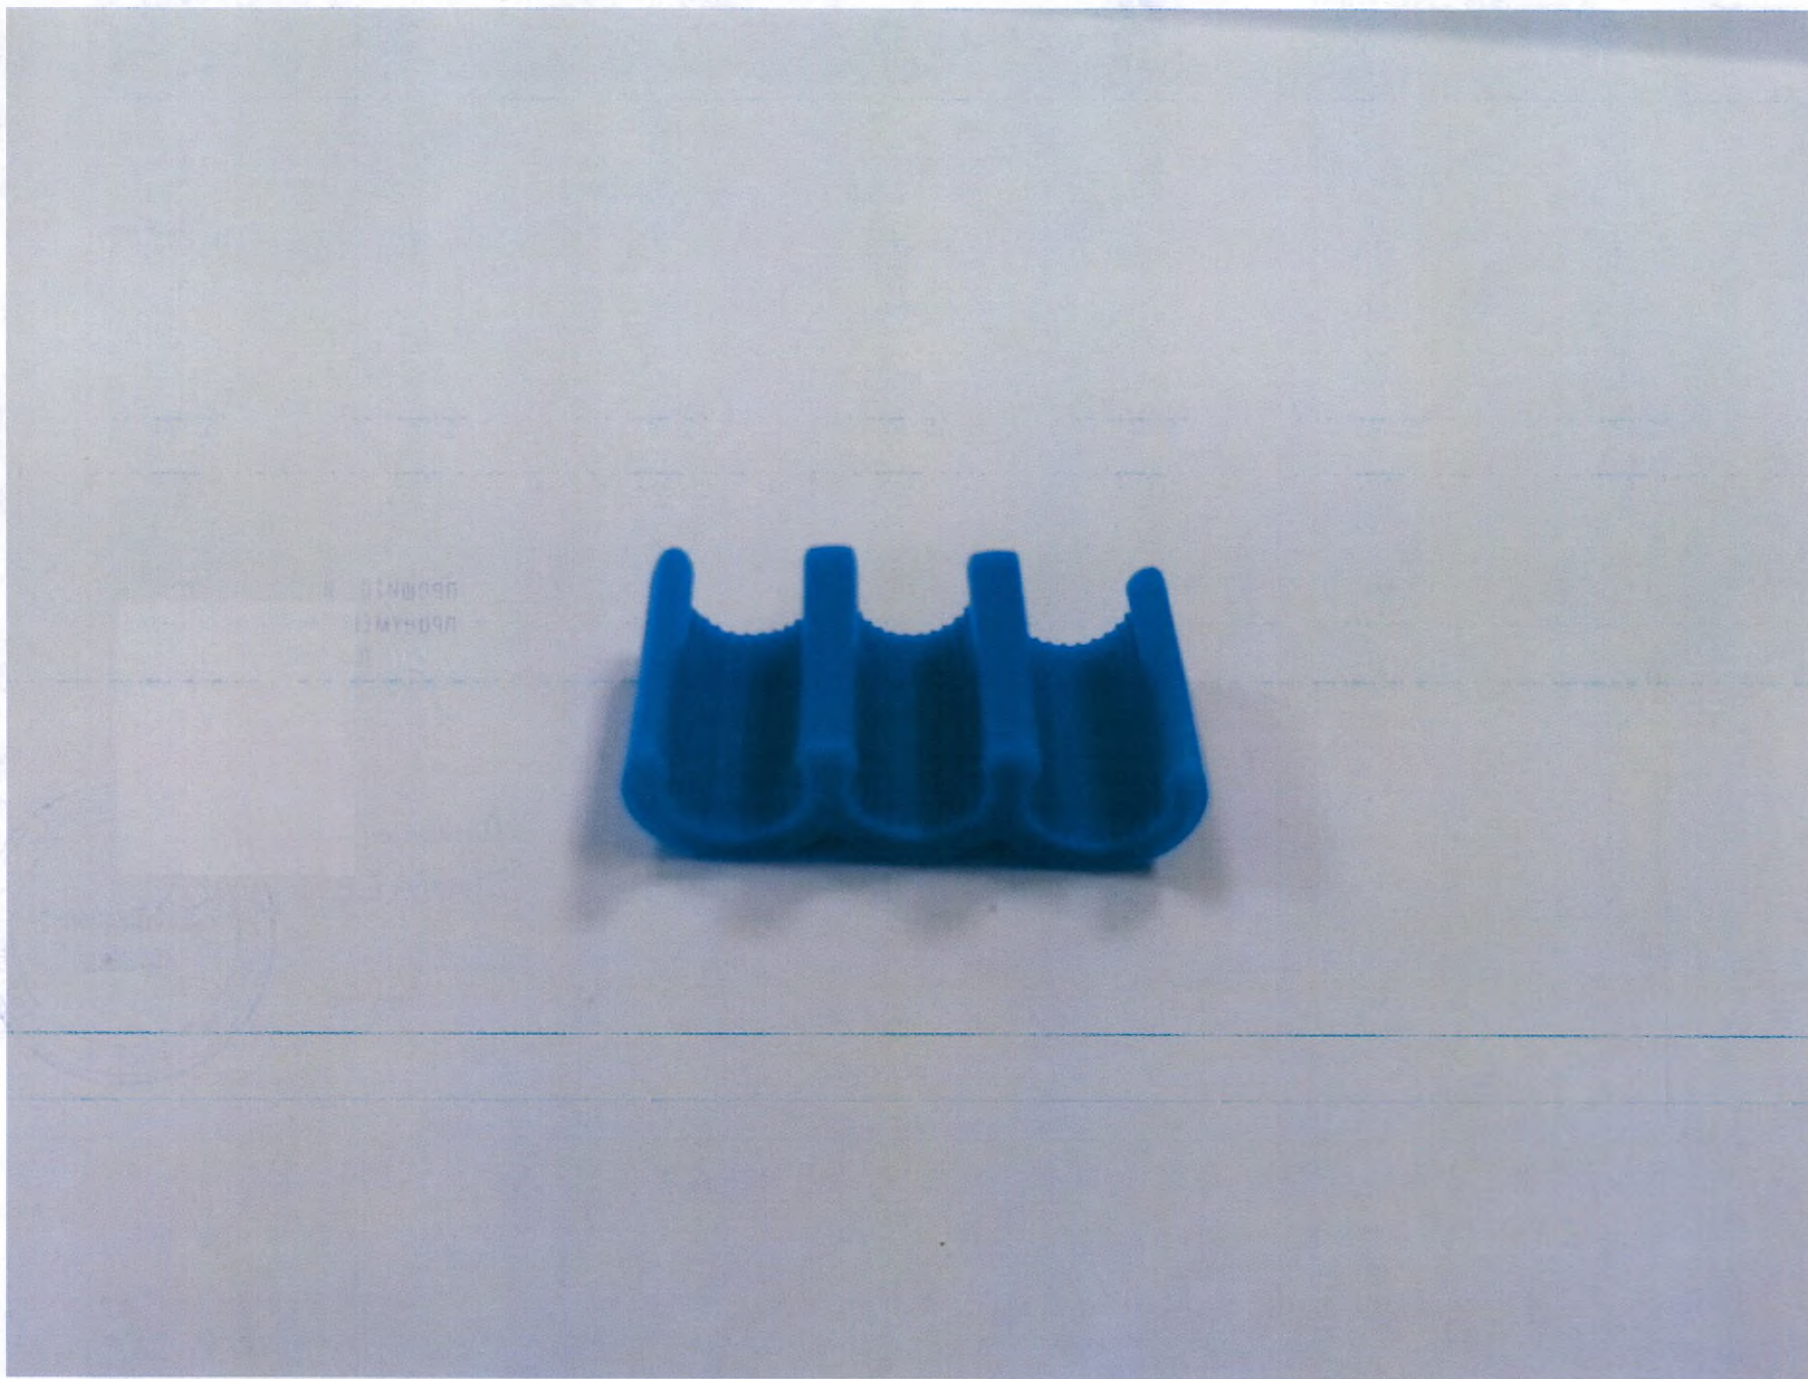

Зажим для крепления защитной трубки

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
54 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

