

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДИАКОН»

А.В. Иванов

2022г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Анализатор автоматический биохимический BioMajesty, в вариантах исполнения JCA-BM6010/C (AUTOMATIC ANALYZER JCA-BM 6010/C), BM6070/C (AUTOMATIC ANALYZER JCA-BM 6070/C)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

JEOL Ltd., Япония

**вариант исполнения JCA-BM6010/C
(AUTOMATIC ANALYZER JCA-BM 6010/C)**


1. Анализатор автоматический биохимический BioMajesty JCA-BM6010/C




2. Раствор термостатирования реакционных кювет Флуориниерт Диэлектрика (Fluoriniert Dialektrika FC- 43)




3. Раствор охлаждающий для лампы C (Lamp Coolant C) – не более 3 флаконов.

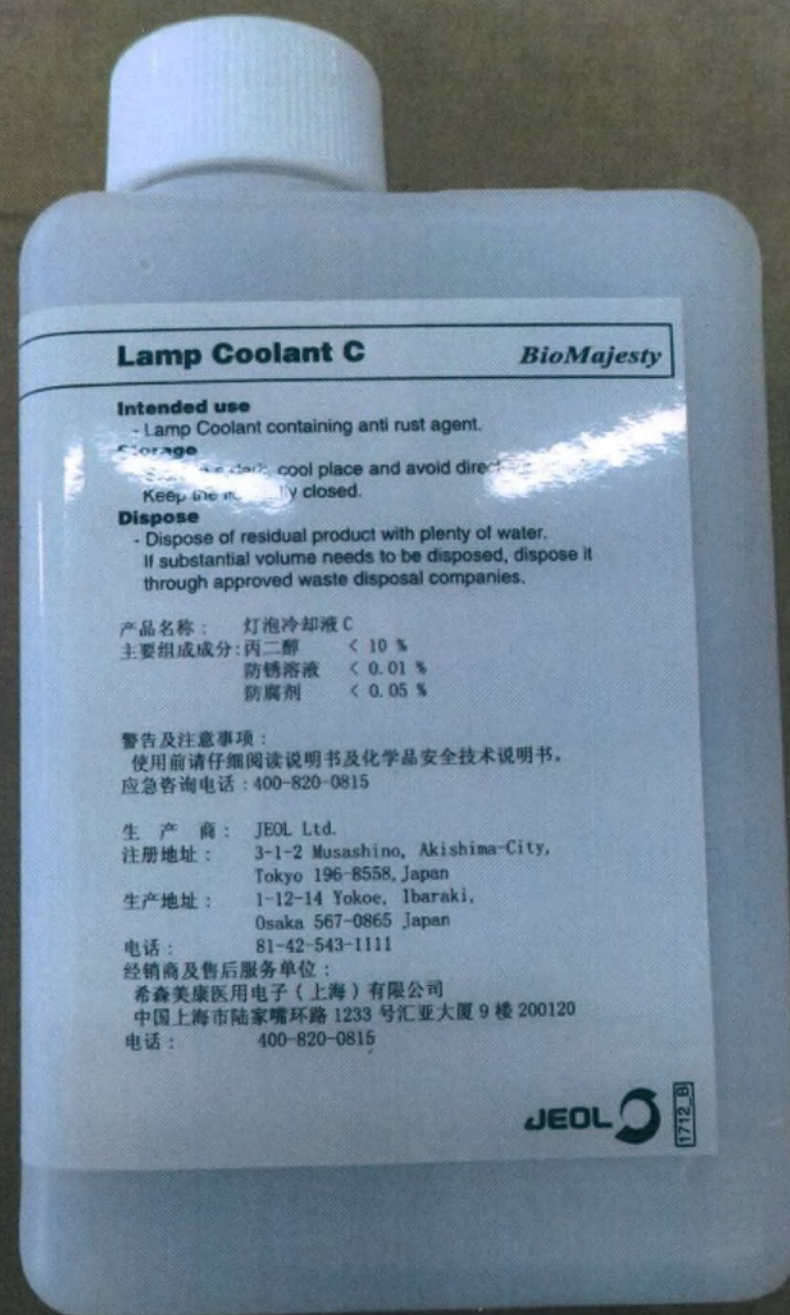

4. Раствор промывающий К для дозатора реагентов (Reagent Probe Wash K) – не более 3 флаконов

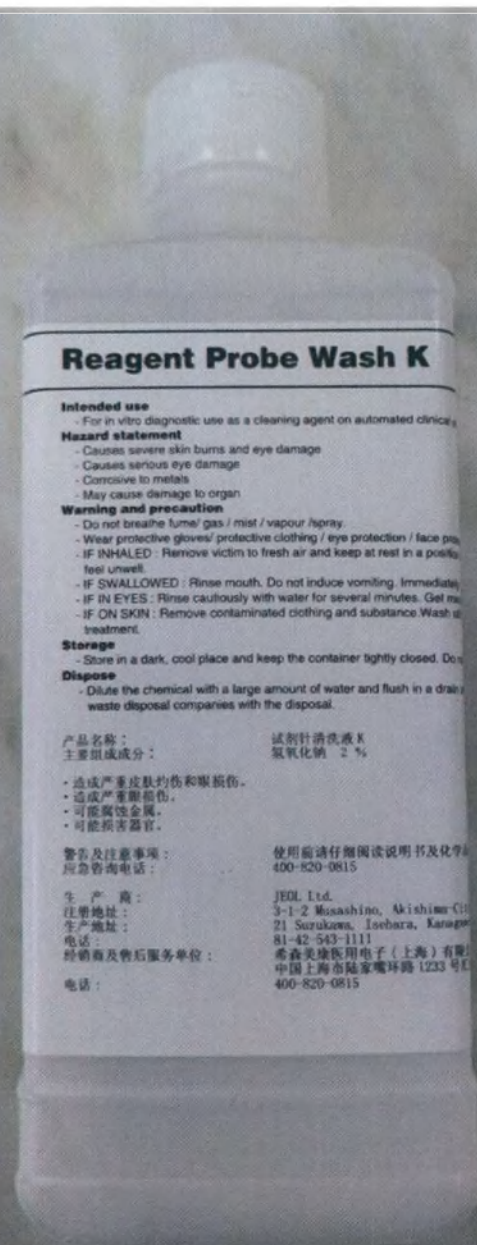

5. Раствор промывающий № 1 для дозатора реагентов (Reagent Probe Wash 1) – не более 5 флаконов.

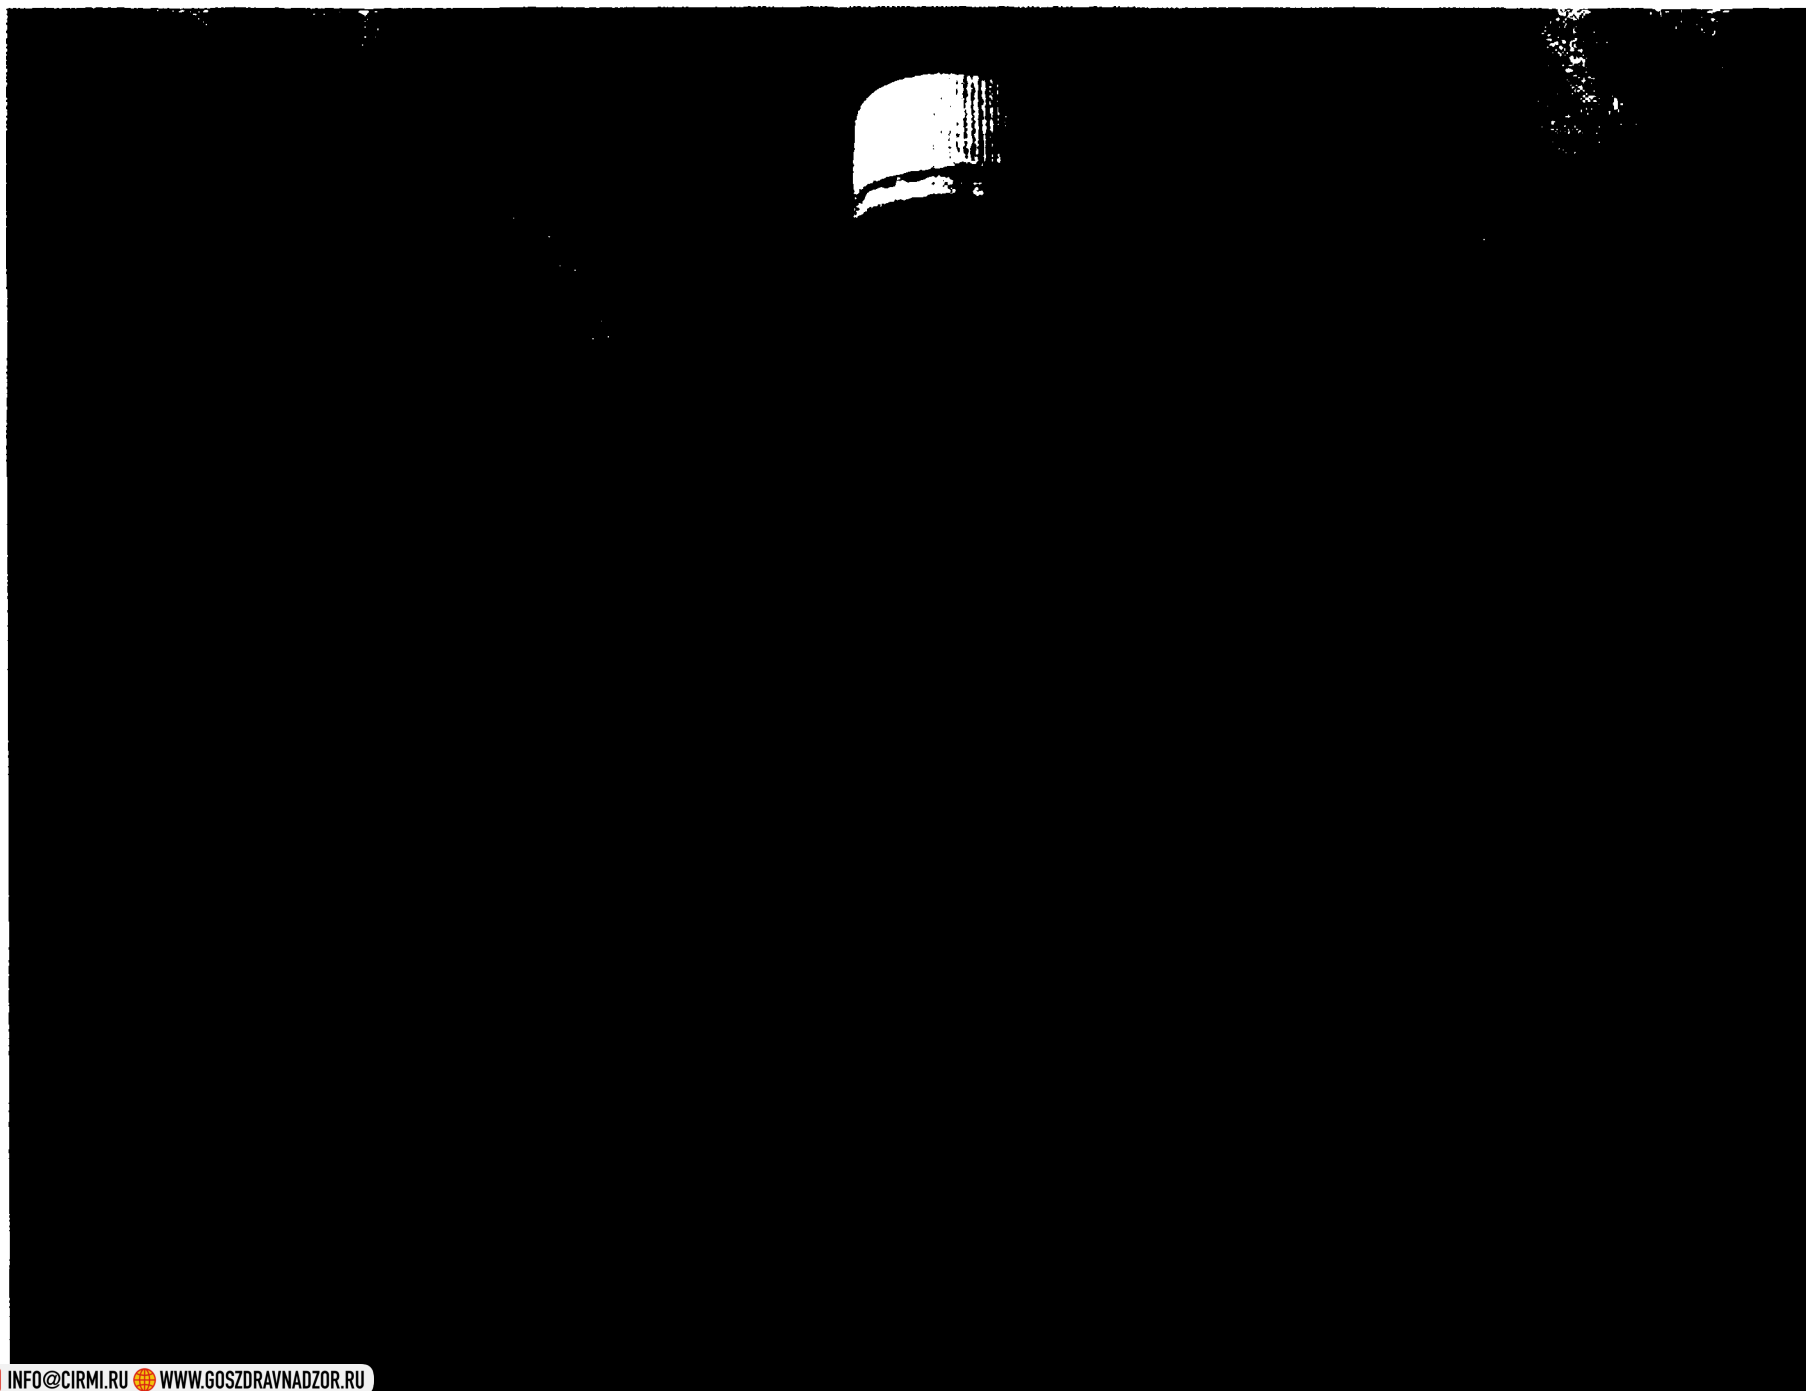


6. Раствор промывающий № 2 для дозатора реагентов (Reagent Probe Wash 2) – не более 5 флаконов.




7. Раствор промывающий S для дозатора реагентов (Reagent Probe Wash S)



8. Раствор промывающий N 7 для кювет (Cuvette Wash Solution 7)

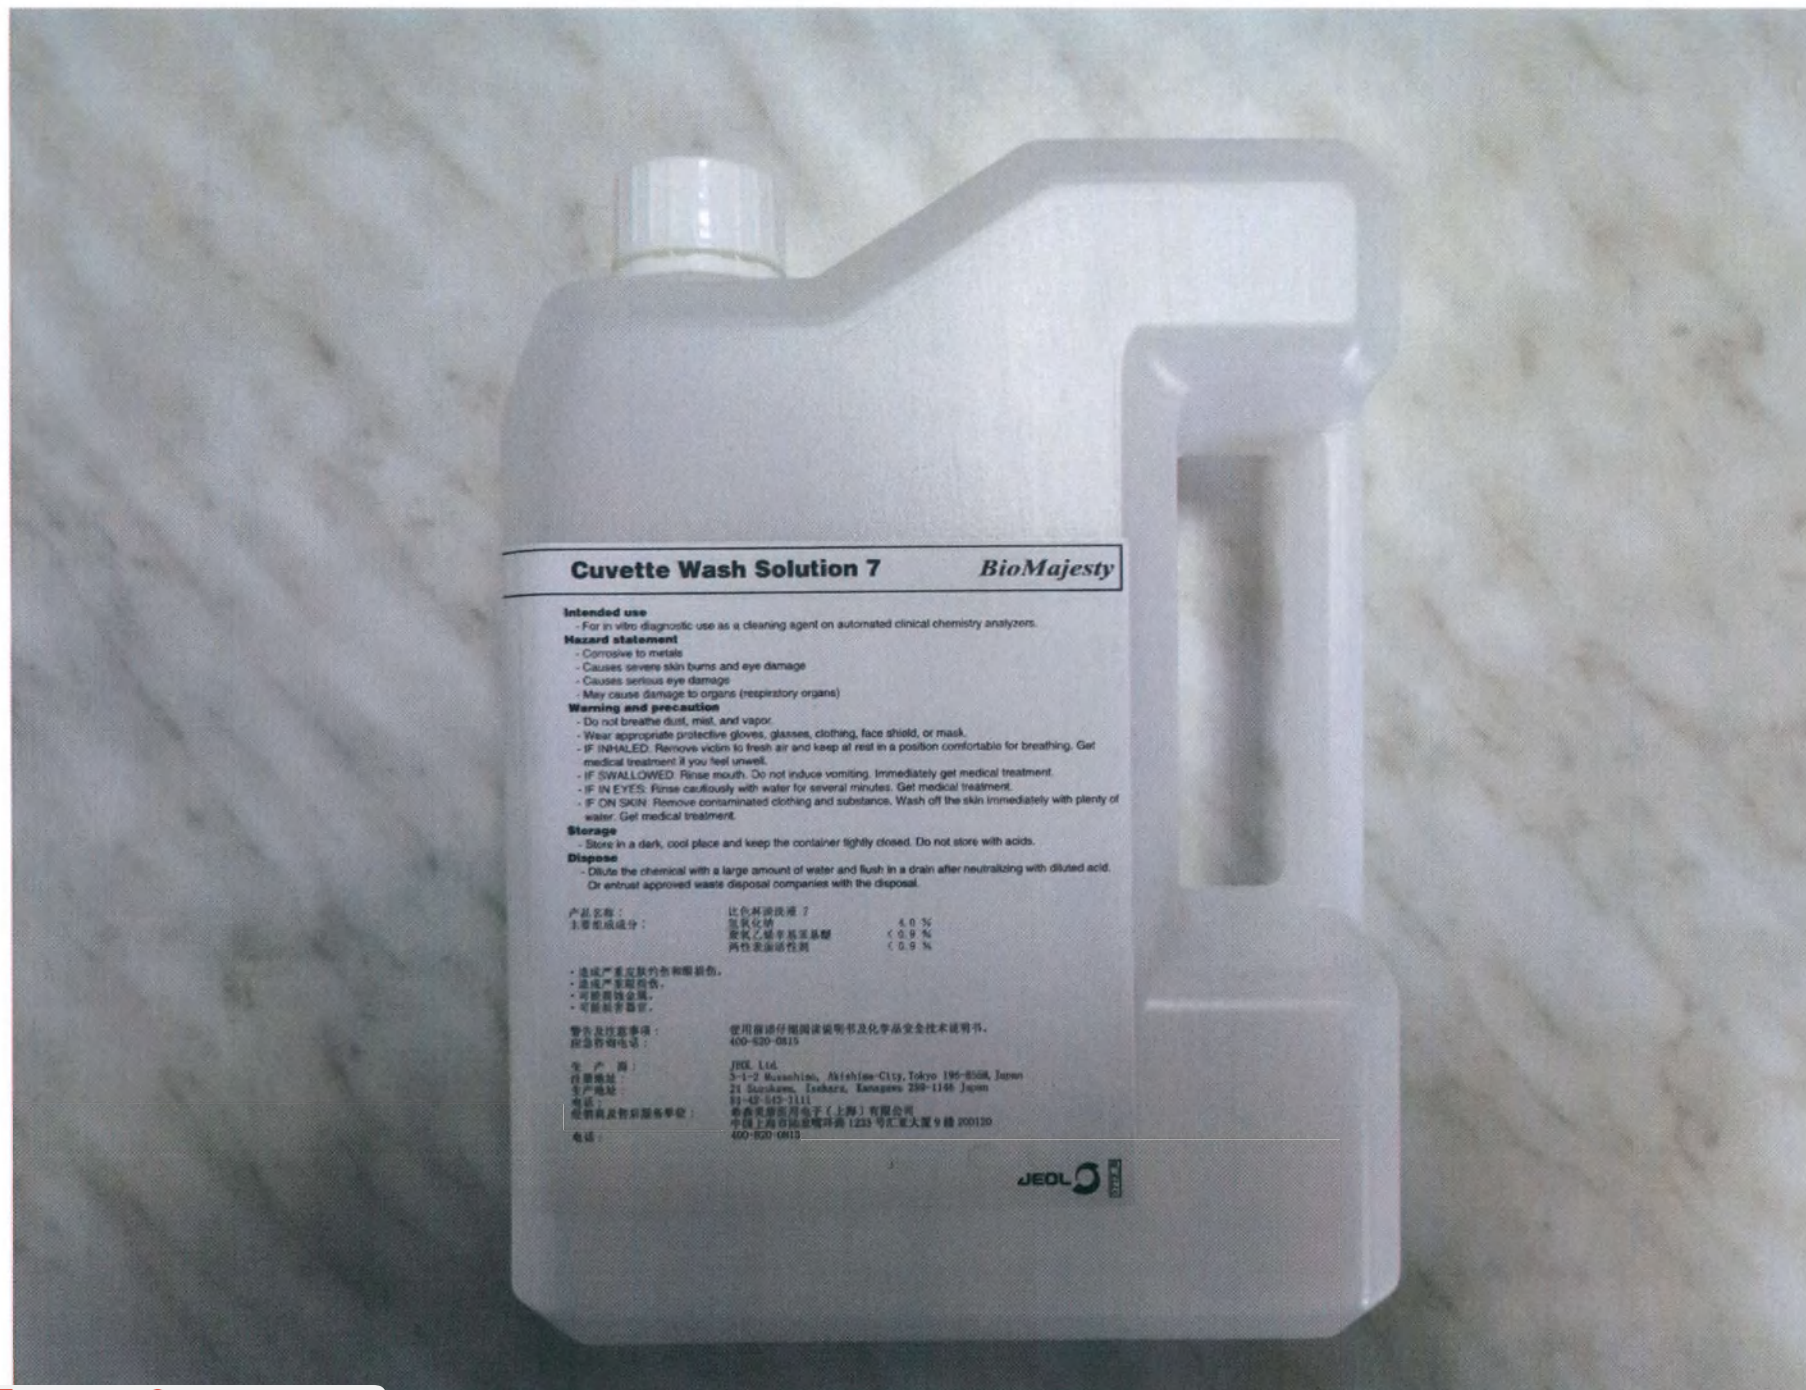


9. Кондиционер для кювет (Cuvette Conditioner Ex)

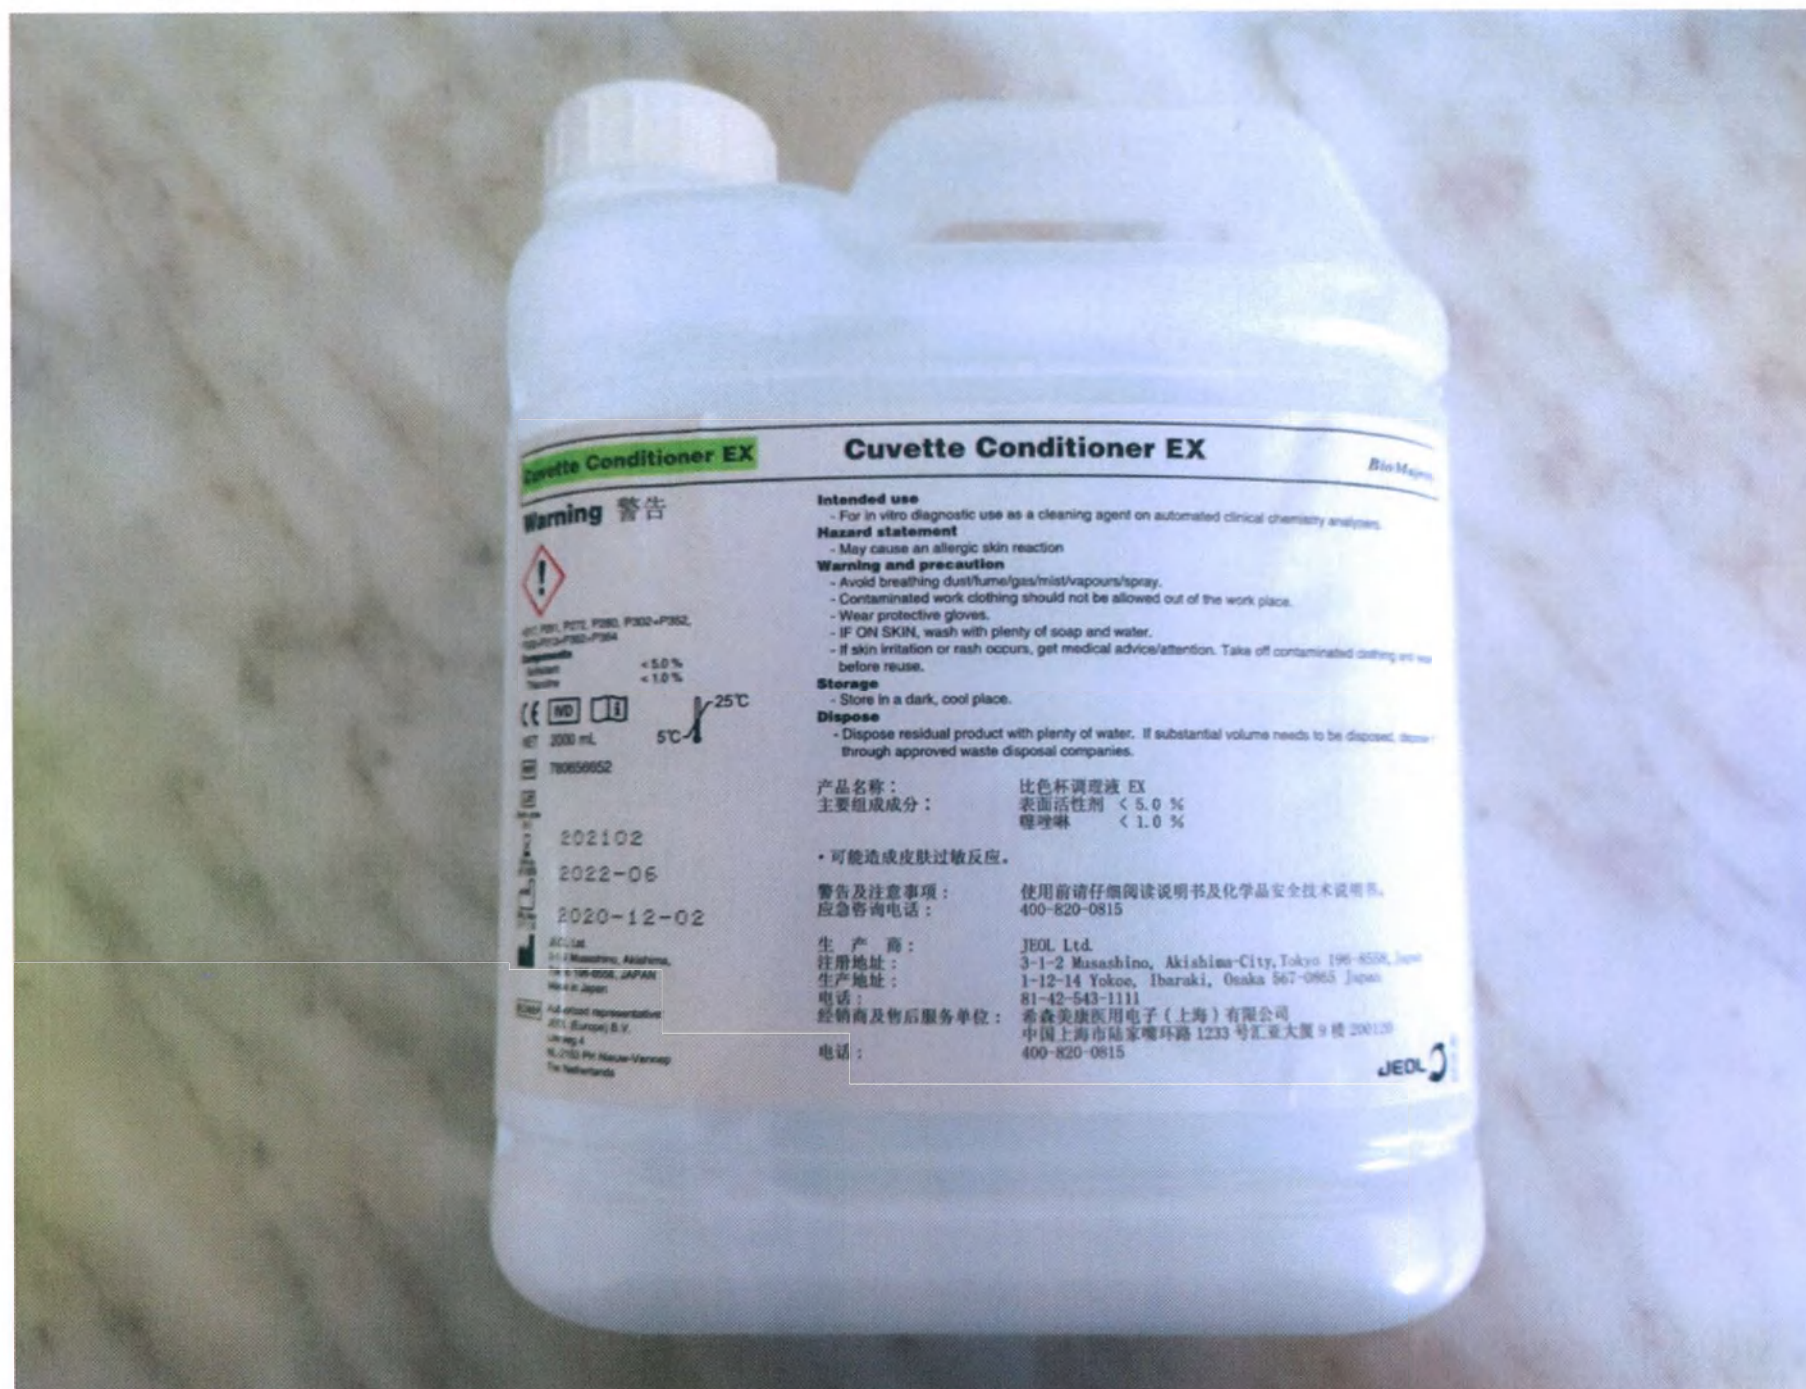

10. Раствор промывающий ионоселективного модуля (ISE Detergent Solution) – не более 4 флаконов.



11. Комплект калибраторов для сыворотки, для ионоселективного модуля (ISE Serum Standard Set): -калибратор для сыворотки низкой концентрации (ISE Serum Low Standard) - не более 3 флаконов; - калибратор для сыворотки высокой концентрации (ISE Serum High Standard) - не более 3 флаконов.

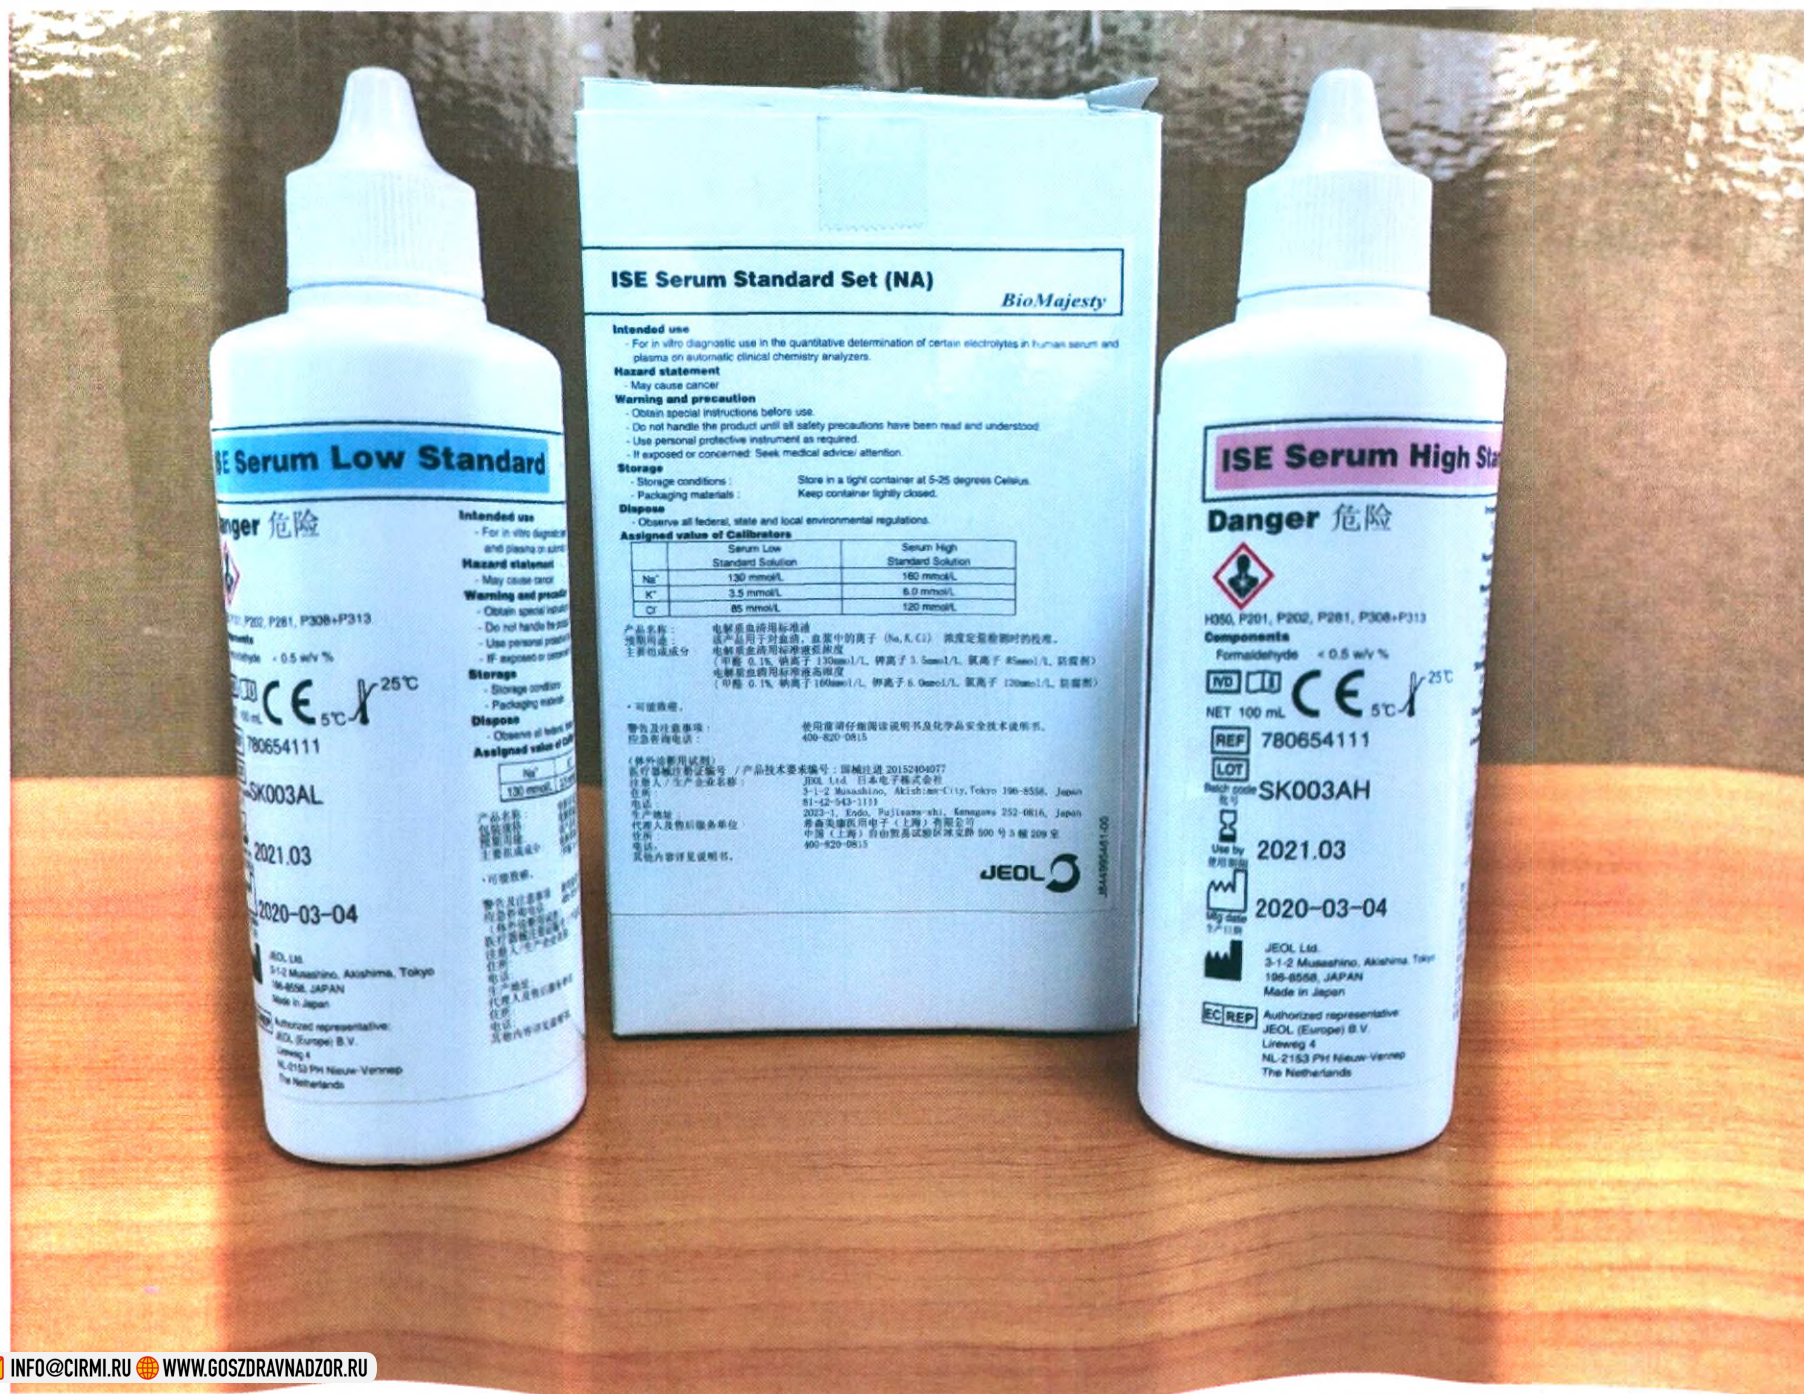


12. Комплект калибраторов для мочи для ионоселективного модуля (ISE Urine Standard Set): -калибратор для мочи низкой концентрации (ISE Urine Low Standard) - не более 3 флаконов; -калибратор для мочи высокой концентрации (ISE Urine High Standard) - не более 3 флаконов.



13. Раствор буферный ионоселективного модуля (ISE Buffer)




14. Электрод ионоселективный натрия (Na Electrode) - не более 3 шт.

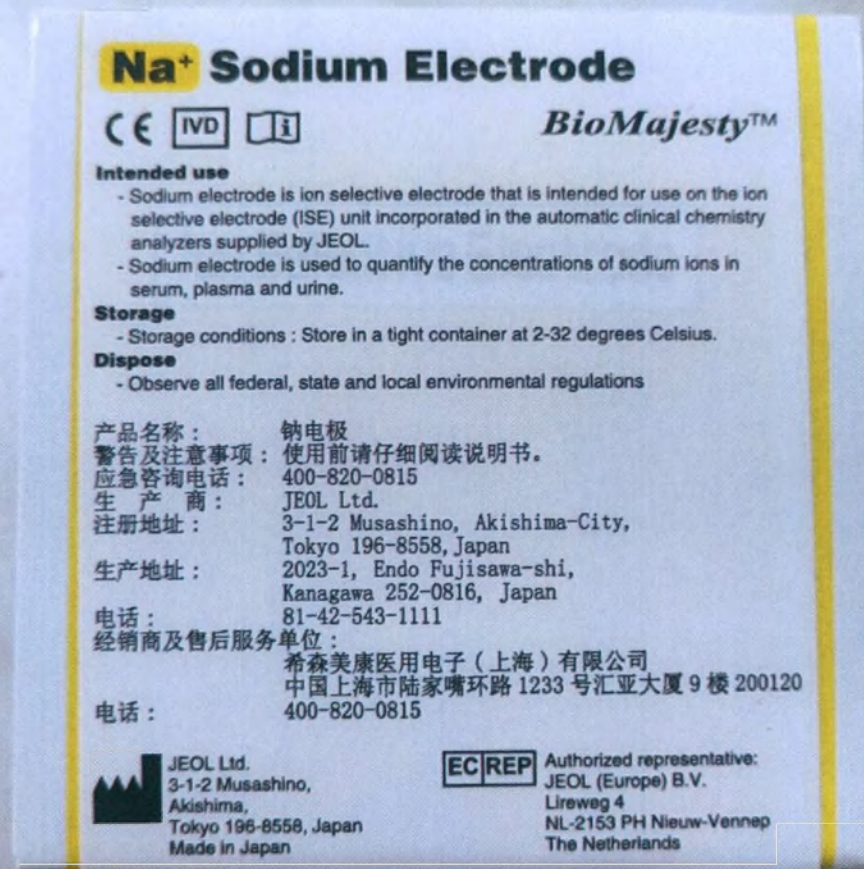

15. Электрод ионоселективный калия (K Electrode) - не более 3 шт.

K⁺ Potassium Electrode



BioMajesty™

Intended use

- Potassium electrode is ion selective electrode that is intended for use on the ion selective electrode (ISE) unit incorporated in the automatic clinical chemistry analyzers supplied by JEOL.
- Potassium electrode is used to quantify the concentrations of potassium ions in serum, plasma and urine.

Storage

- Storage conditions : Store in a tight container at 2-32 degrees Celsius.


Dispose

- Observe all federal, state and local environmental regulations

产品名称： 钾电极
警告及注意事项： 使用前请仔细阅读说明书。
应急咨询电话： 400-820-0815
生产商： JEOL Ltd.
注册地址： 3-1-2 Musashino, Akishima-City,
Tokyo 196-8558, Japan
生产地址： 2023-1, Endo Fujisawa-shi,
Kanagawa 252-0816, Japan
电话： 81-42-543-1111
经销商及售后服务单位：
希森美康医用电子（上海）有限公司
中国上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 9 楼 200120
电话： 400-820-0815



JEOL Ltd.
3-1-2 Musashino,
Akishima,
Tokyo 196-8558, Japan
Made in Japan



Authorized representative:
JEOL (Europe) B.V.
Lireweg 4
NL-2153 PH Nieuw-Vennep
The Netherlands

16. Электрод ионоселективный хлора (Cl Electrode) - не более 3 шт.

Cl Chloride Electrode



BioMajesty™

Intended use

- Chloride electrode is ion selective electrode that is intended for use on the ion selective electrode (ISE) unit incorporated in the automatic clinical chemistry analyzers supplied by JEOL.
- Chloride electrode is used to quantify the concentrations of chloride ions in serum, plasma and urine.

Storage

- Storage conditions : Store in a tight container at 2-32 degrees Celsius.

Dispose

- Observe all federal, state and local environmental regulations

产品名称： 氯电极
警告及注意事项： 使用前请仔细阅读说明书。
应急咨询电话： 400-820-0815
生产商： JEOL Ltd.
注册地址： 3-1-2 Musashino, Akishima-City,
Tokyo 196-8558, Japan
生产地址： 2023-1, Endo Fujisawa-shi,
Kanagawa 252-0816, Japan
电话： 81-42-543-1111
经销商及售后服务单位：
希森美康医用电子（上海）有限公司
中国上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 9 楼 200120
电话： 400-820-0815



JEOL Ltd.
3-1-2 Musashino,
Akishima,
Tokyo 196-8558, Japan
Made in Japan



Authorized representative:
JEOL (Europe) B.V.
Lireweg 4
NL-2153 PH Nieuw-Vennep
The Netherlands

17. Крышка электродного блока (Electrode cover)



18. Винт крепления крышки электродного блока (Screw) - не более 3 шт.



19. Кольцо уплотнительное для установки электродов (O-ring) - не более 3 шт.



20. Электрод сравнения (Reference Electrode) - не более 3 шт.

Ref. Reference Electrode

CE IVD i **BioMajesty™**

Intended use

- Reference electrode is intended for use on the ion selective electrode (ISE) unit incorporated in the automatic clinical chemistry analyzers supplied by JEOL.
- Reference electrode is used to quantify the concentrations of inorganic ions in serum, plasma and urine.

Storage


- Storage conditions : Store in a tight container at 2-32 degrees Celsius.

Dispose


- Observe all federal, state and local environmental regulations

产品名称 : 参比电极
警告及注意事项 : 使用前请仔细阅读说明书。
应急咨询电话 : 400-820-0815
生产商 : JEOL Ltd.
注册地址 : 3-1-2 Musashino, Akishima-City,
Tokyo 196-8558, Japan
生产地址 : 2023-1, Endo Fujisawa-shi,
Kanagawa 252-0816, Japan
电话 : 81-42-543-1111
经销商及售后服务单位 : 希森美康医用电子(上海)有限公司
中国上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦9楼 200120
电话 : 400-820-0815

 JEOL Ltd.
3-1-2 Musashino,
Akishima,
Tokyo 196-8558, Japan
Made in Japan

 Authorized representative:
JEOL (Europe) B.V.
Lireweg 4
NL-2153 PH Nieuw-Vennep
The Netherlands


21. Калибратор ионоселективного модуля внутреннего расположения (Internal Standard)

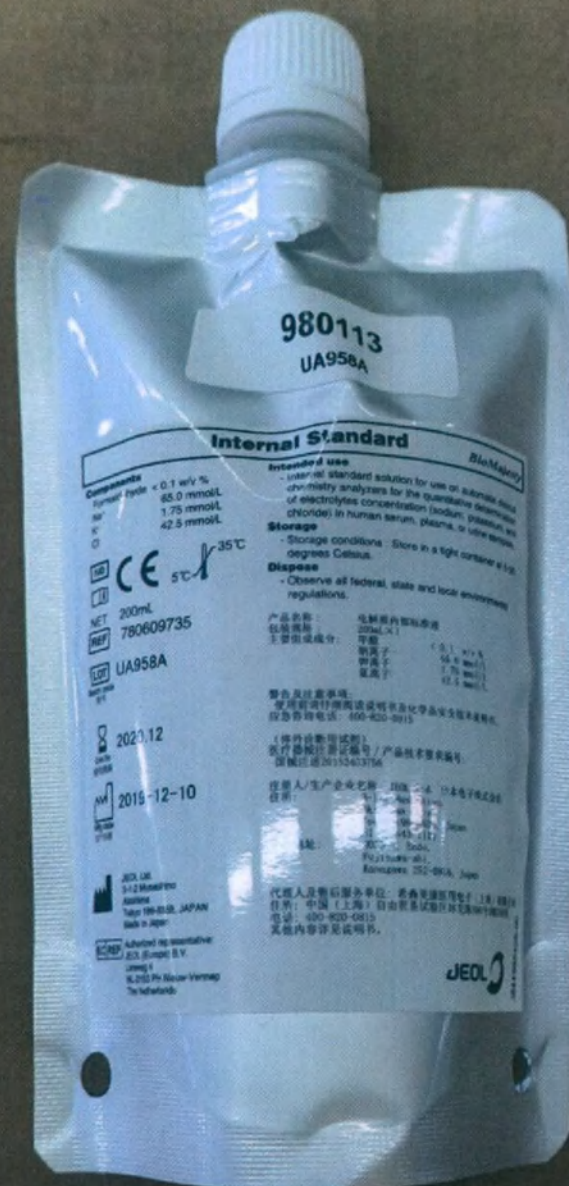

22. Скаты деревянные для установки прибора (Ramp made from wood) - не более 4 шт.



23. Игла дозатора образцов (Sample probe Pipette for SPP)

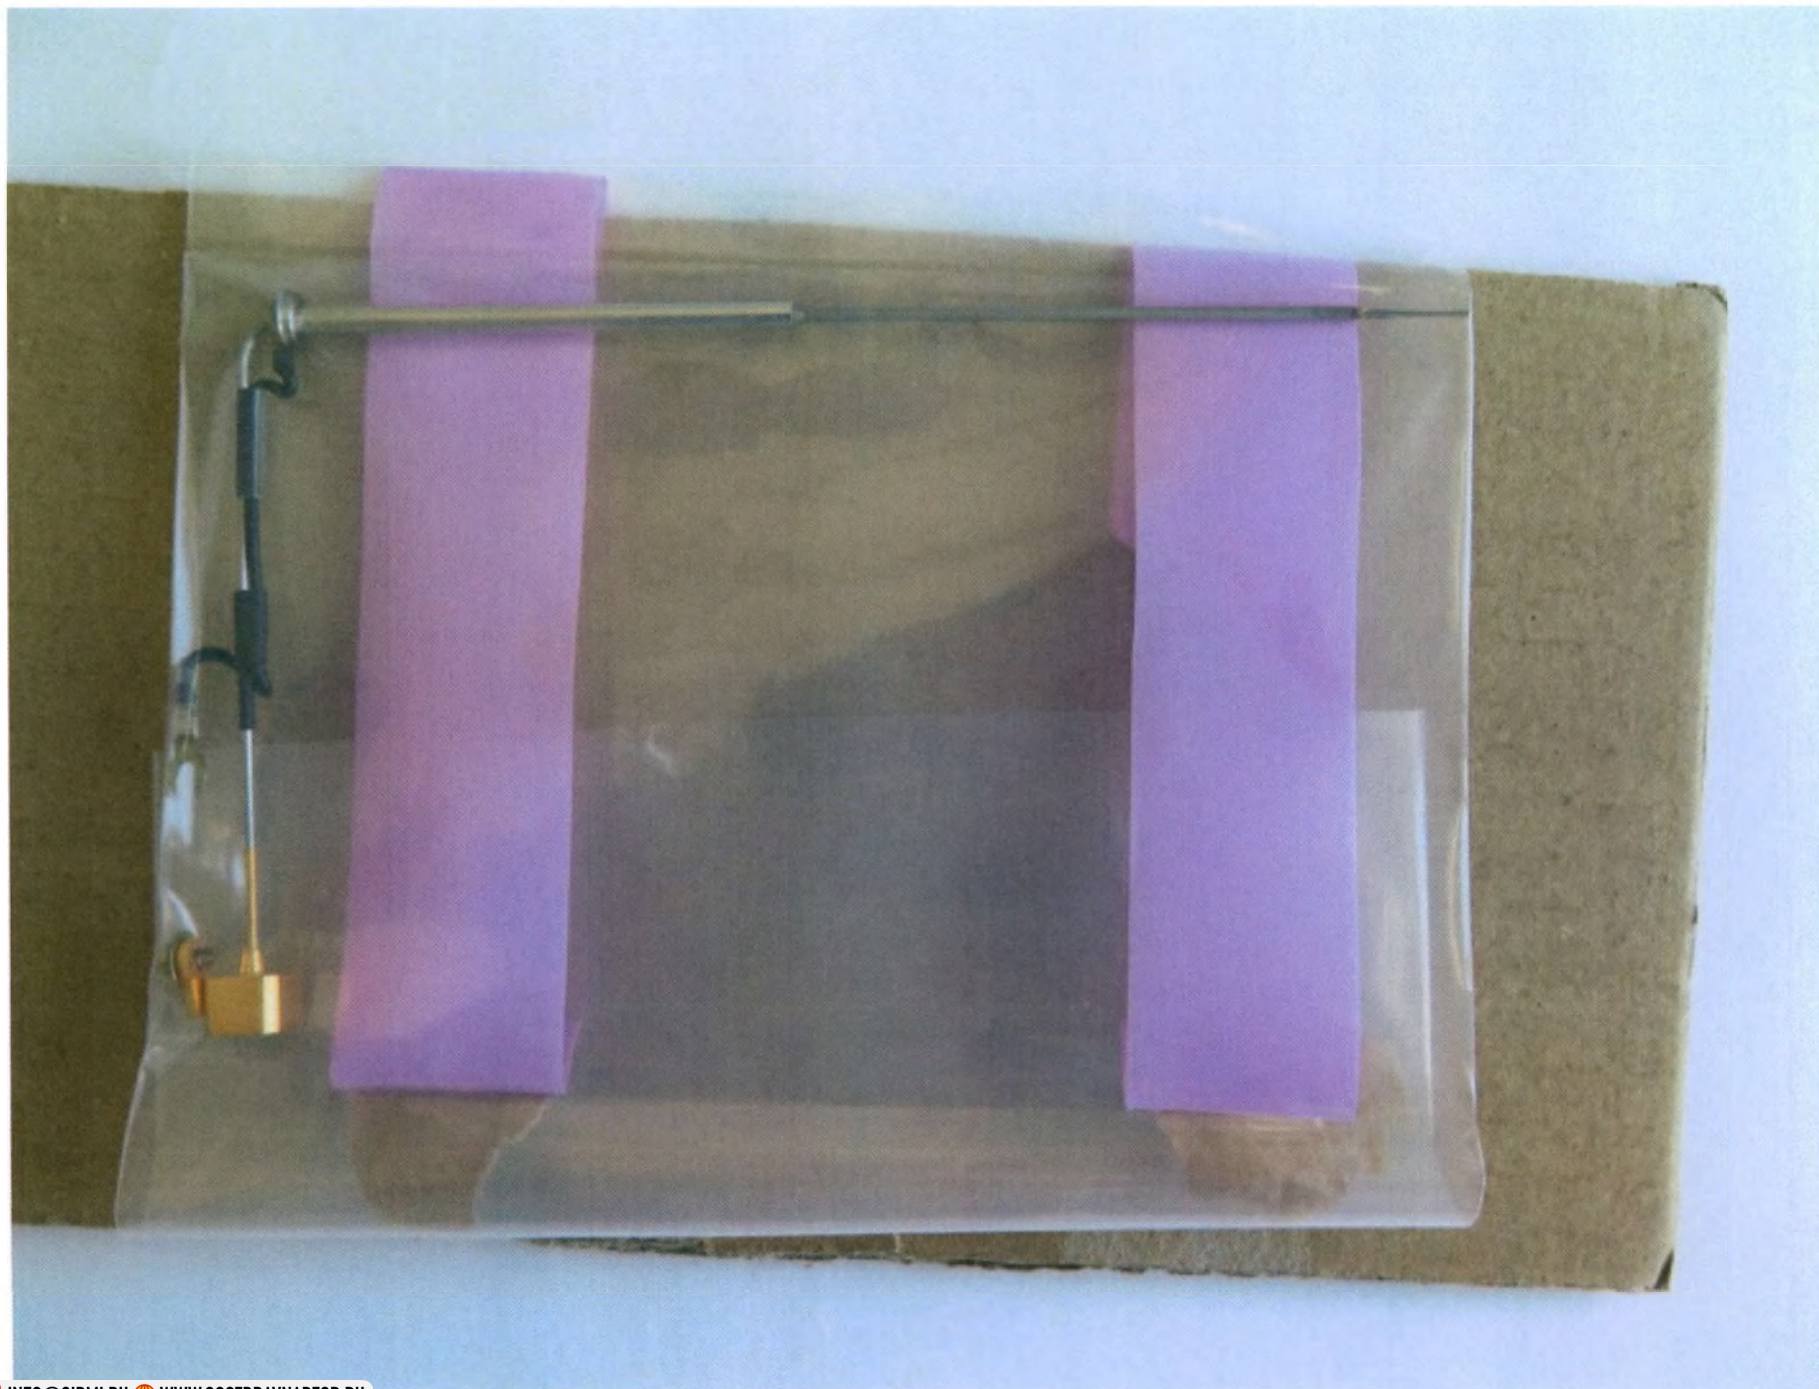

24. Загрузчик срочной пробы (Stat Port Lever)




25. Замок верхней крышки (Top cover Bracket)




26. Крышка отсека лампы (Face cover).



27. Папка с инструкциями (Instruction Manual (Bracket))

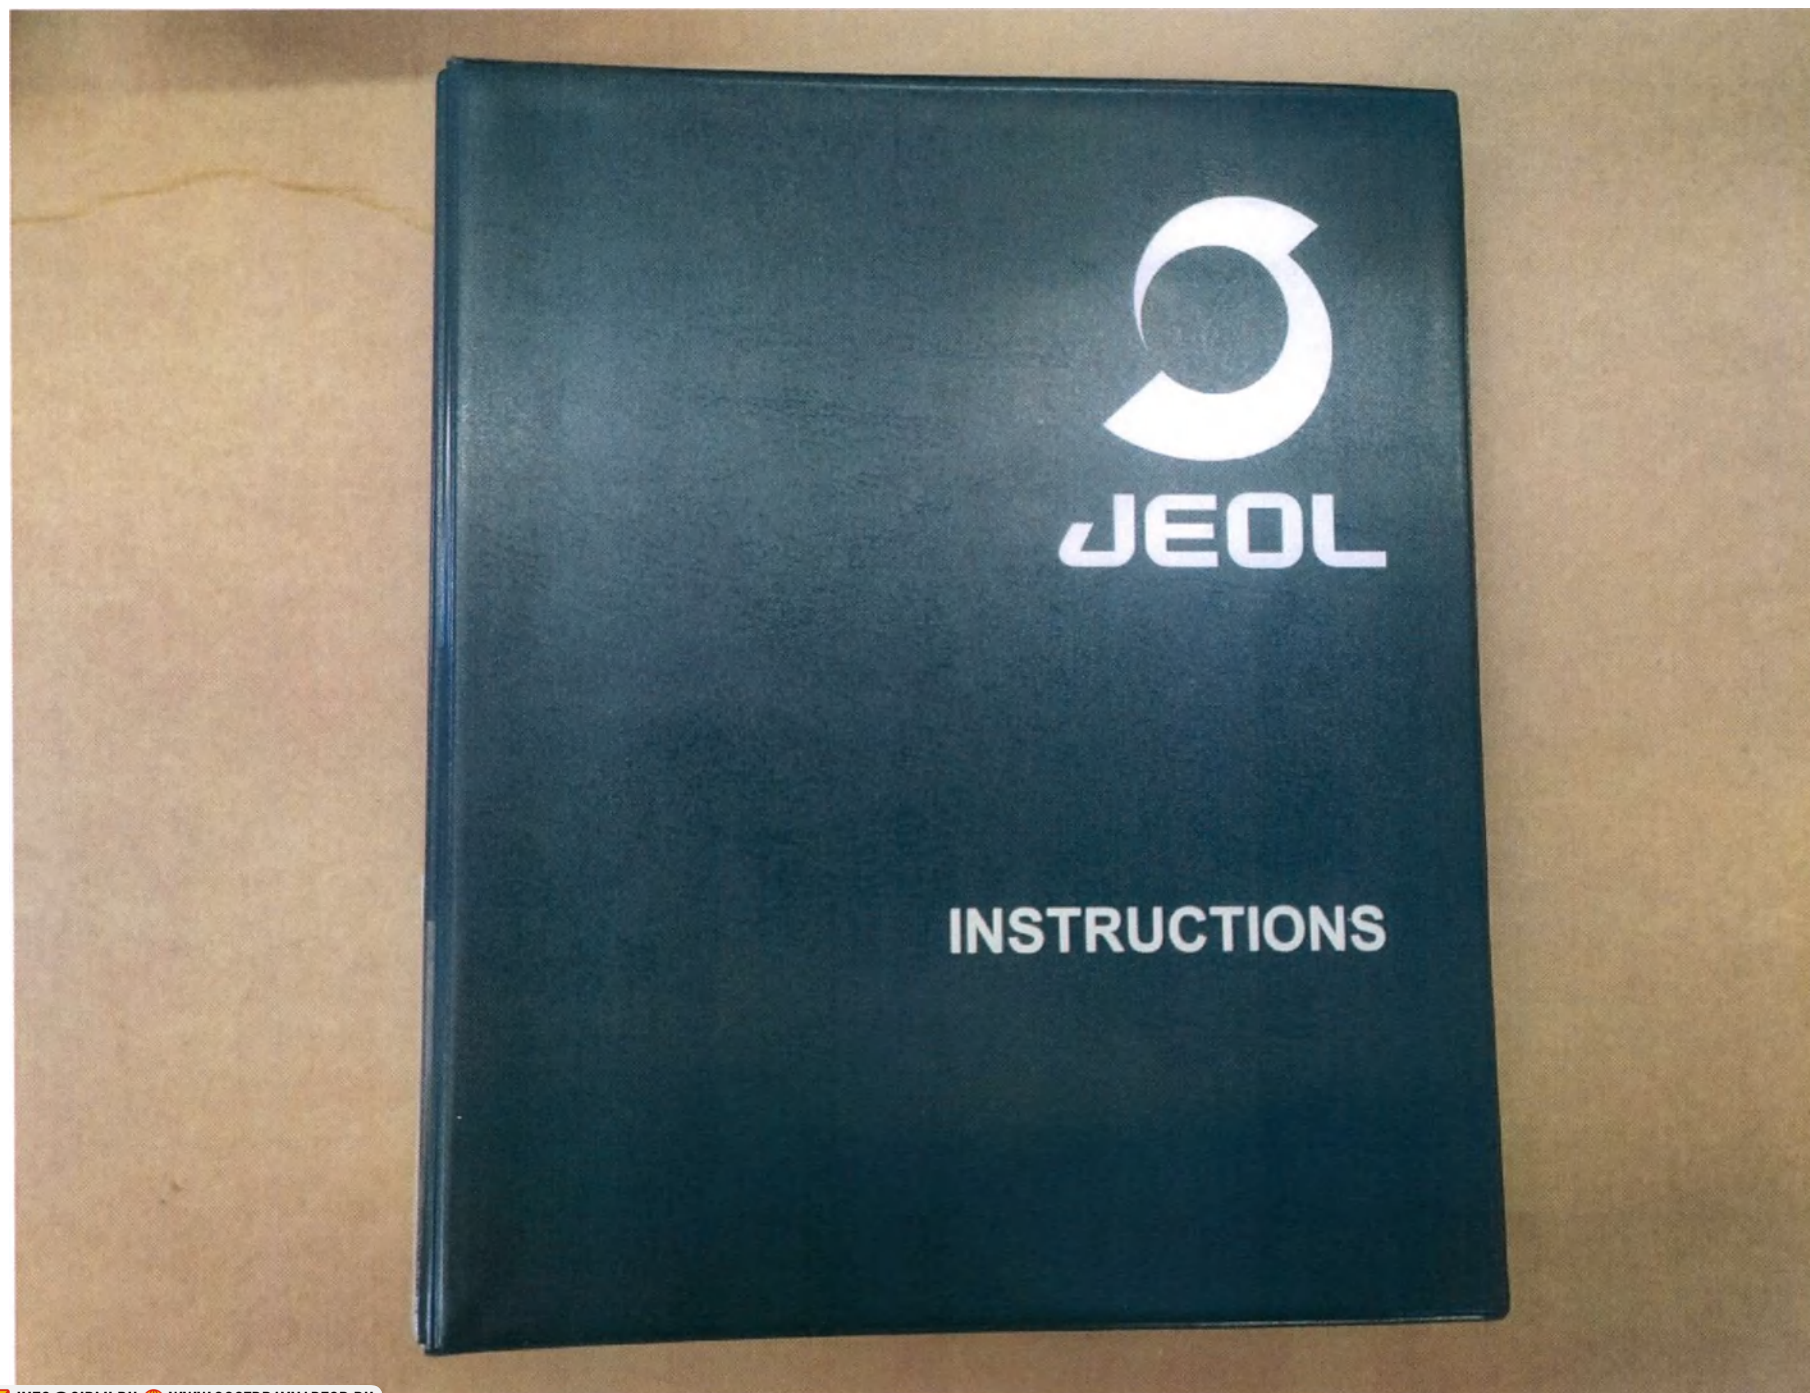

28. Руководство пользователя (Instruction Manual)

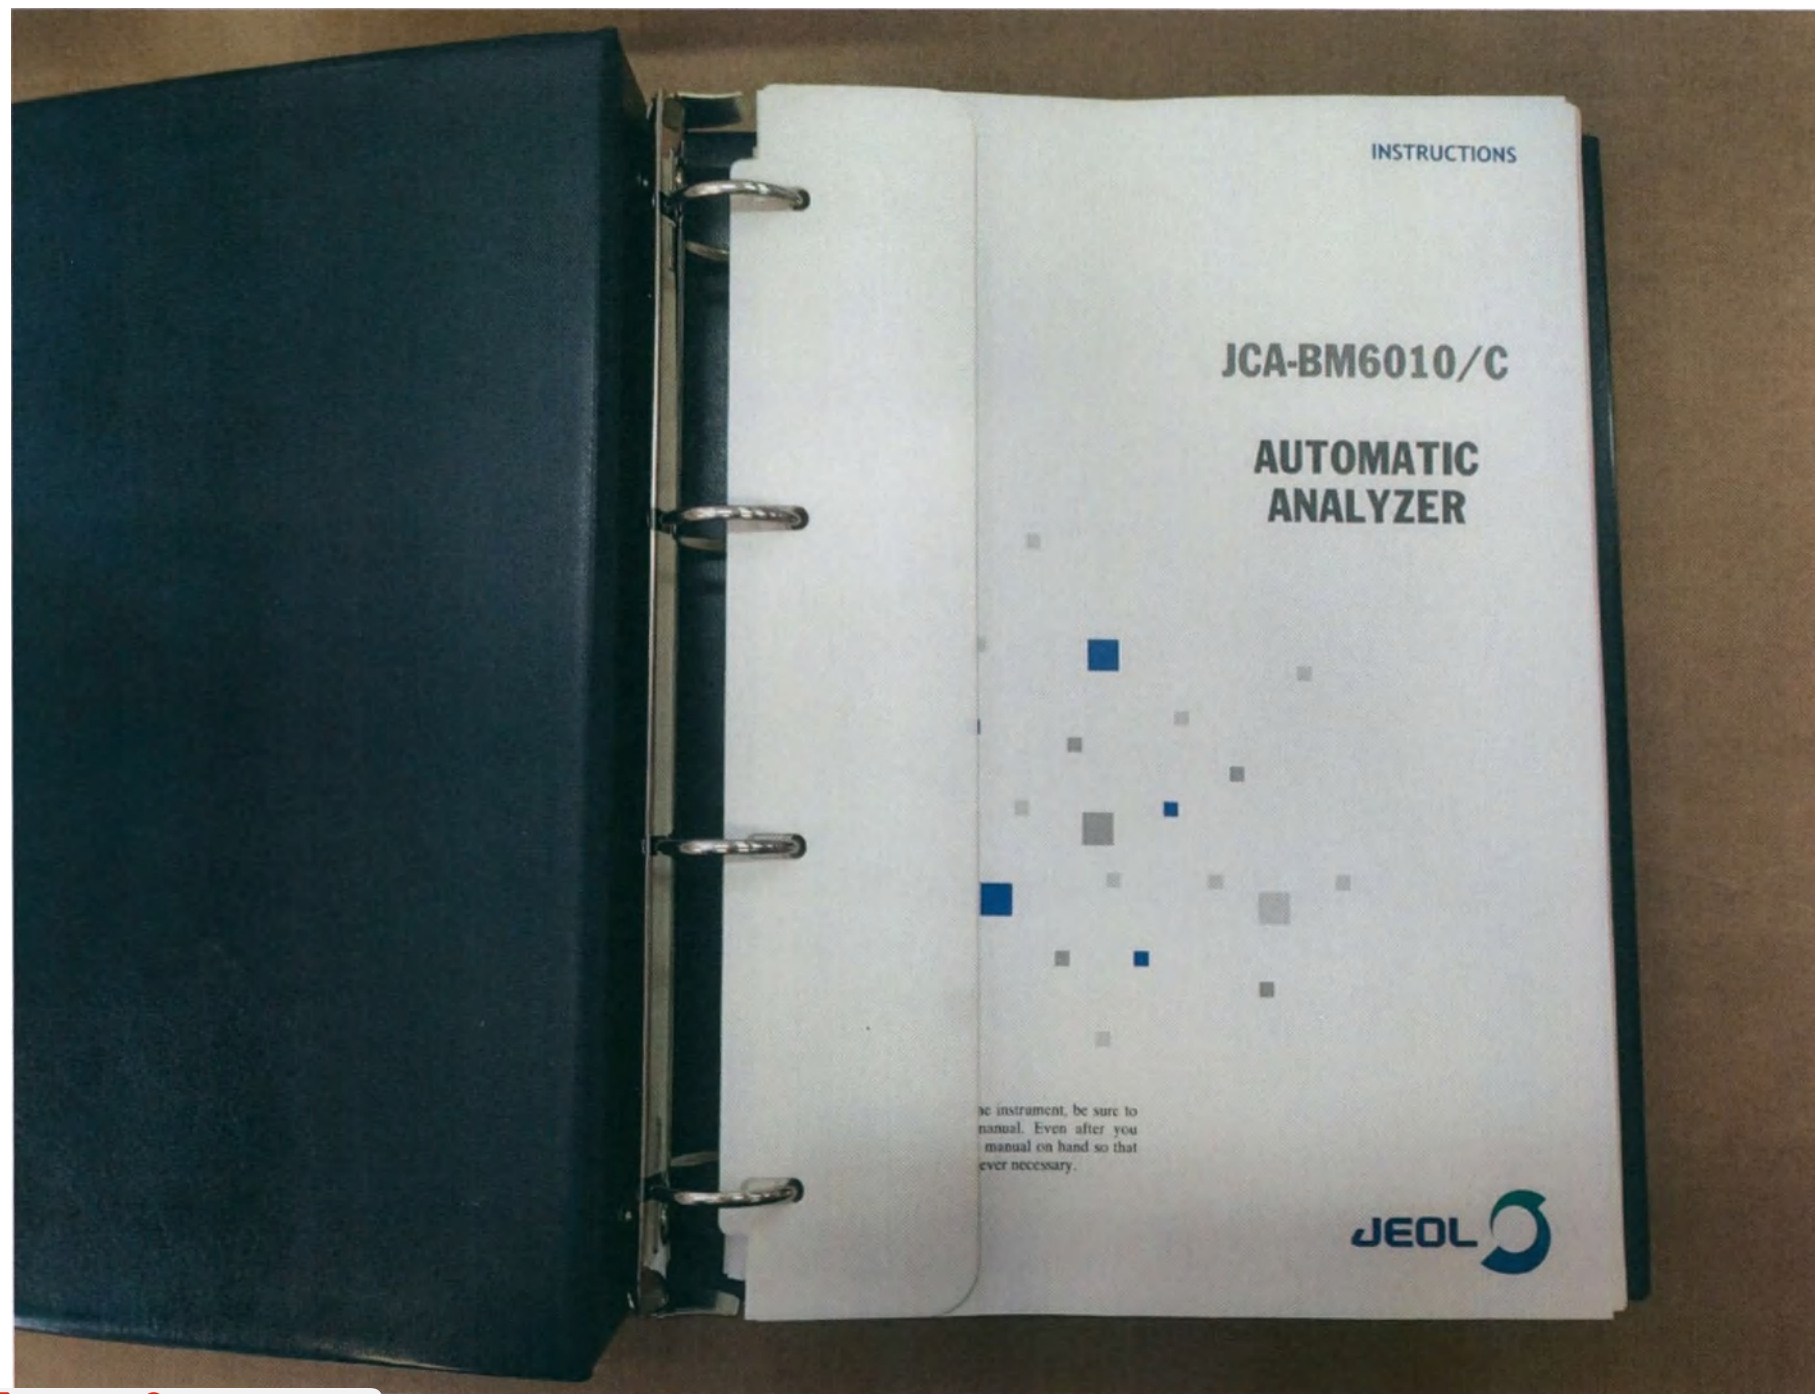

29. Декларация соответствия (Declaration of Conformity)

PH. NO. CA1110833

JEOL

CERTIFICATION

Instrument : AUTOMATIC ANALYZER

Model : JCA-EM6010/C

Serial no. : CA1401000740074

This is to certify that the subject instrument has passed the final performance inspection at our factory.

DATE OF INSPECTION: Jan. 18. 2013

INSPECTED BY: *[Signature]*

APPROVED BY: *Fujino*


MANAGER : KIYOTAKA FUJINO

INSPECTION DEPARTMENT : Medical Equipment Business Operations
Business Management Division
Quality Assurance and Regulatory Affairs Group

JEOL Ltd./日本電子
Tokyo, Japan

V-6012-08
2012.04

30. Сертификат соответствия производителя (Inspection Certificate)

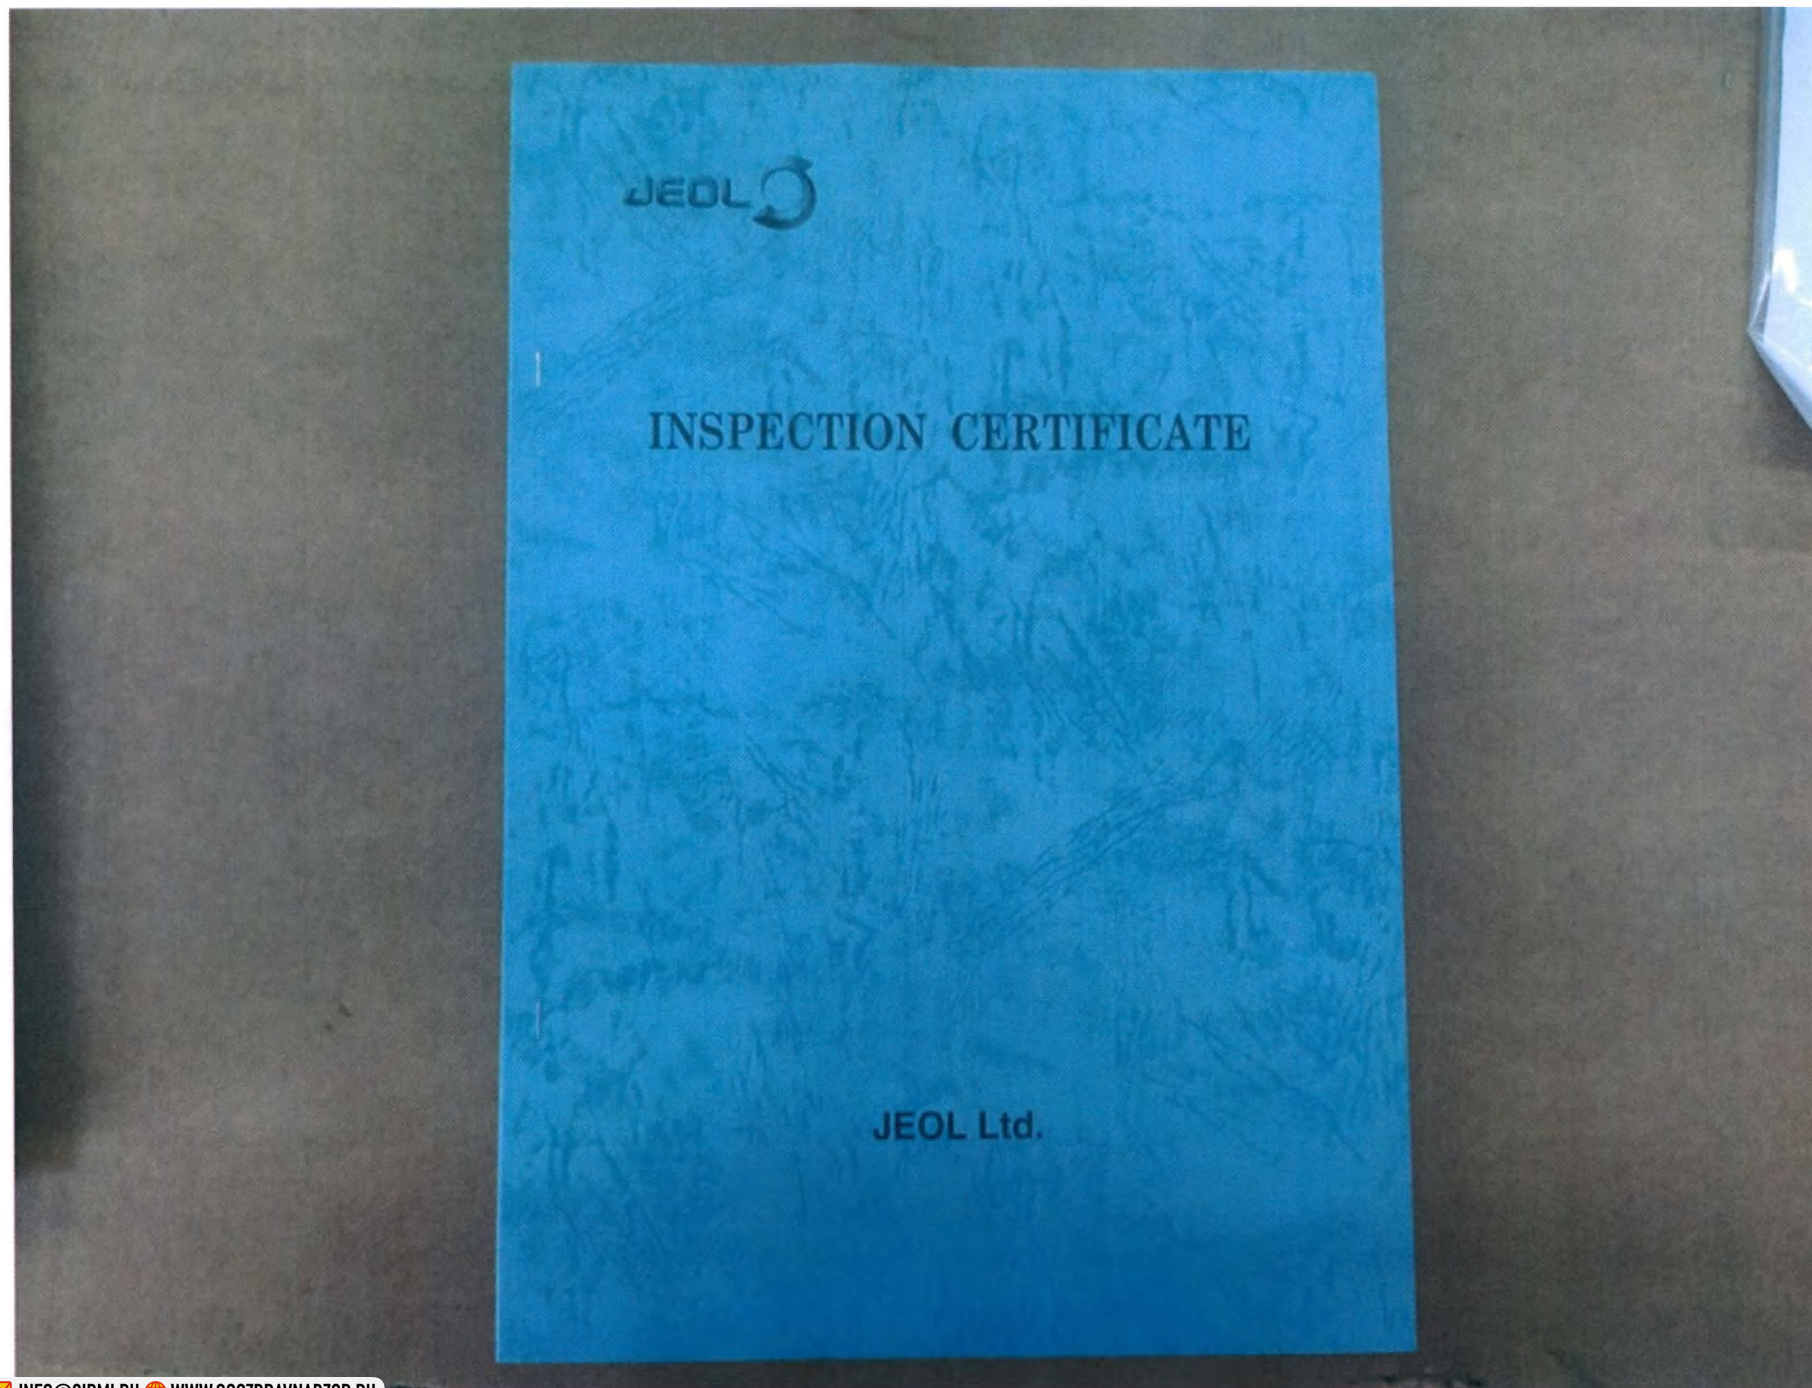

31. Лист проверки для сервисной службы (Reference Data for Engineers)

REFERENCE DATA
FOR ENGINEER

CUSTOMER: DIASYS DIAGNOSTIC
SYSTEMS GMBH GERMANY

MODEL: JCA-BM6010/C

SERIAL No.: CA1401005130513

MANUFACTURING No.: CA20J0089

AUTHORIZED BY: PRODUCT
DEPARTMENT

DATE OF INSPECTION : Jul.1.2020

INSPECTED BY : A. Sato

APPROVED BY : [Signature]

JEOL LTD. / 日本電子
TOKYO, JAPAN

32. Руководство по установке и снятию замка верхней крышки (Information for installation)

Ref No: Pr-09-MED-000004

October 28, 2009

Mechanical Design Team

Medical Equipment Business Operations

JEOL Ltd.

Installation and Removal Procedure for the fixing brackets of BM6010/C Top Cover

1. Outline

Top Cover of BM6010/C system has Automatic Locking Mechanism.

This document describes the procedures for installation of the fixing brackets on the top cover at the time of system installation at customer site.

2. Installation Procedure for the Fixing Brackets of the Top Cover

1) Install the fixing bracket on the front side of the analyzer.

Cover the rubber feet with the protection sheet and fix it with masking tape.

Remove the holder and fix the fixing bracket on the front side of the analyzer, using M4x10 hexagon socket head cap screws.

Keep the removed holder and screws together in a plastic bag.

Masking tape Protection sheet Holder



Remove the holder and screws,
and keep them together in a plastic bag.

Fixing bracket on the front side




M4x10 hexagon socket head cap screws,
Plain washers, Spring washers

2) Install the fixing bracket on the back side of the analyzer.

Remove 2 M4x6 screws on the back cover. Keep the removed screws in a plastic bag.

Fix the fixing bracket on the back side of the analyzer with M4x8 hexagon socket head cap screws.

33. Диск оптический для установки программы BM6010C (BM6010C System program setup disk)

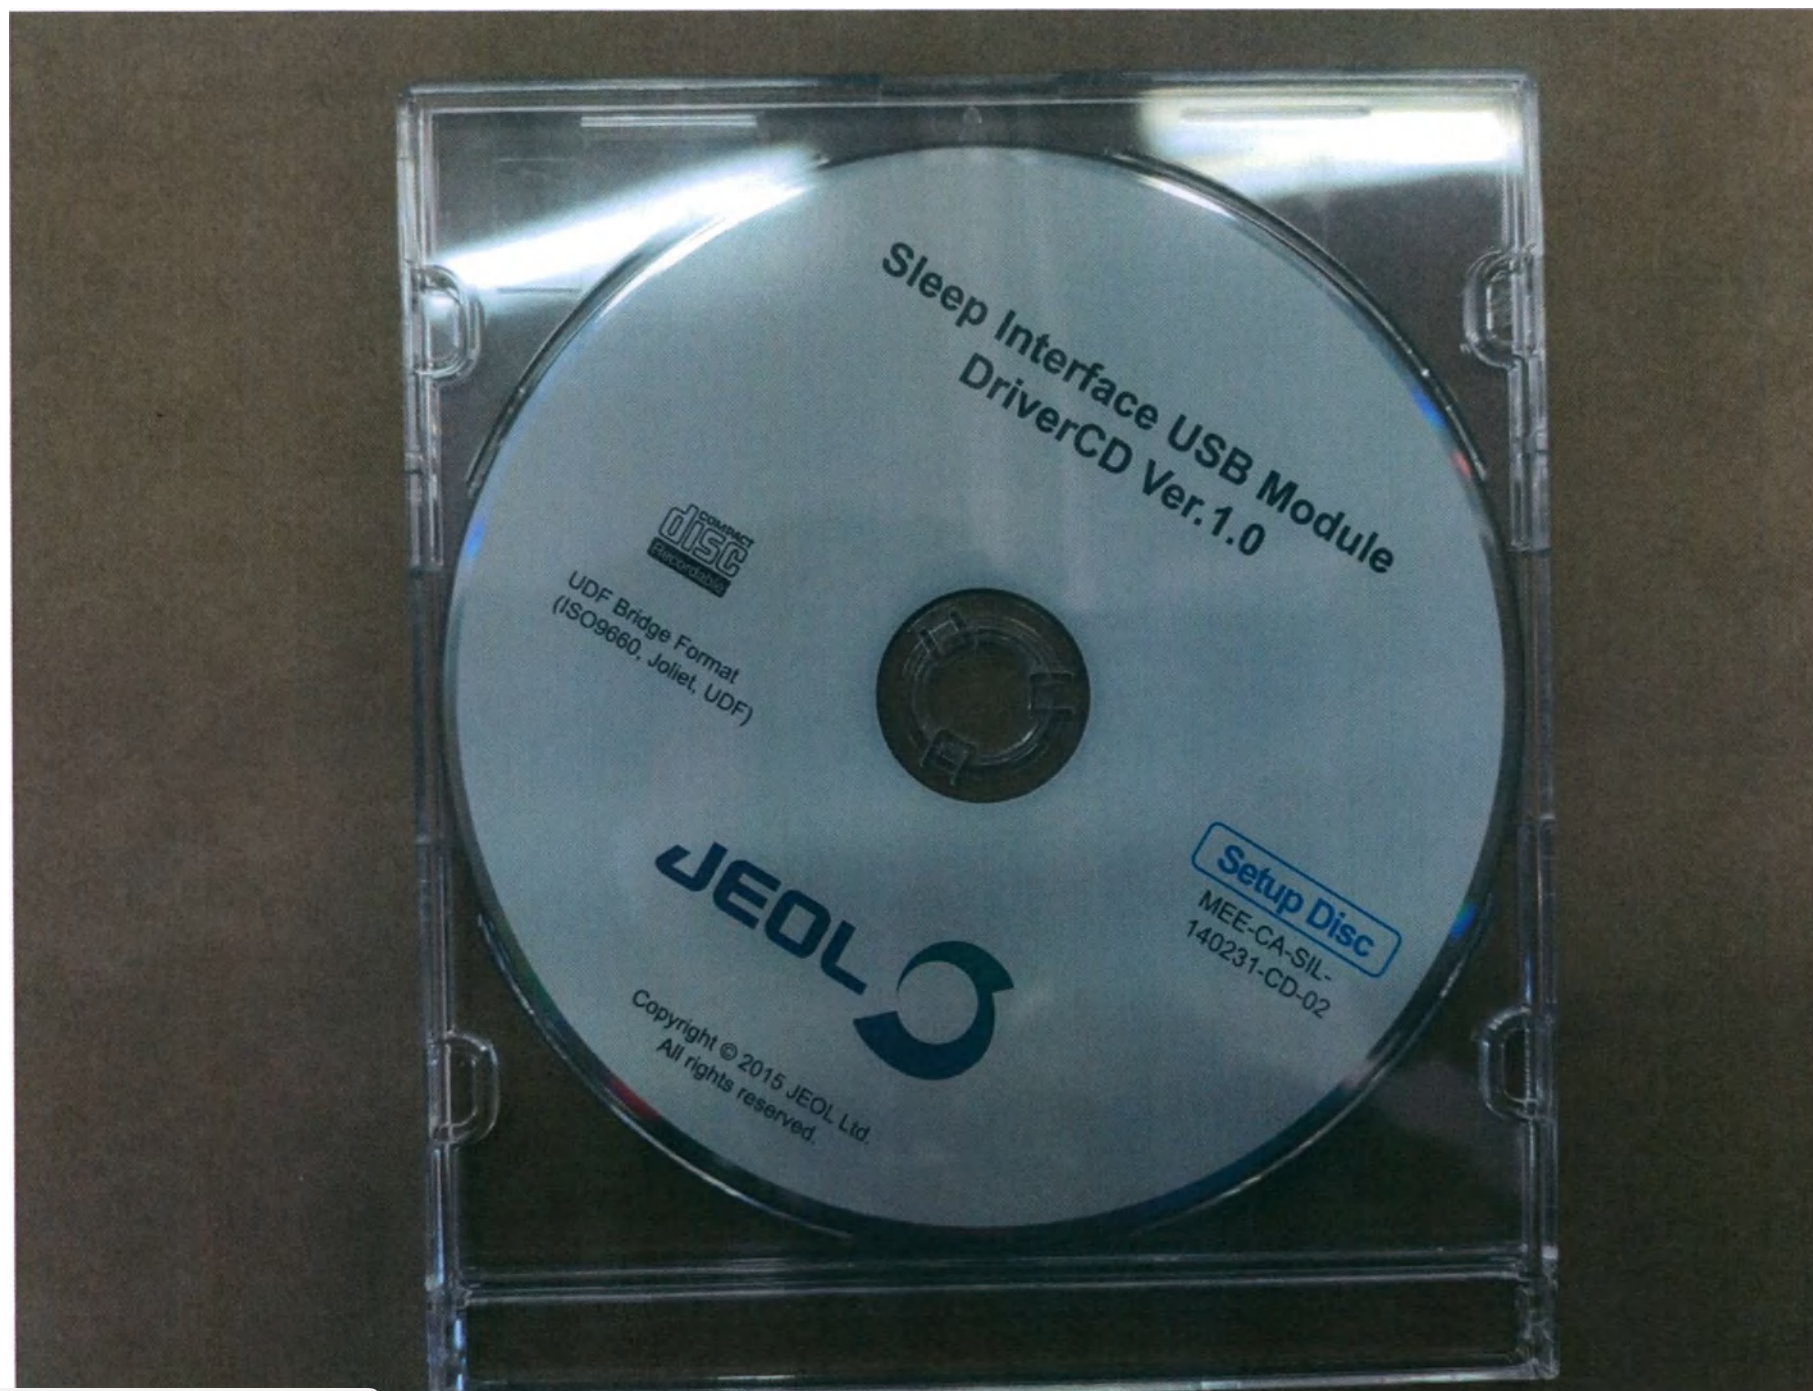

34. Диск оптический с данными для восстановления программы (BM6010C System program backup disk)



35. Диск оптический для резервирования данных с прибора (Blank disk)



36. Канистра для промывающего раствора N 7 для кювет (Cuvette Wash Solution 7 empty bottle)




37. Канистра для кондиционера для кювет (Cuvette Conditioner empty bottle)




38. Канистра для раствора инкубационной ванны (Incubation Bath Oil empty bottle)



39. Ротор для образцов (Sample tray)

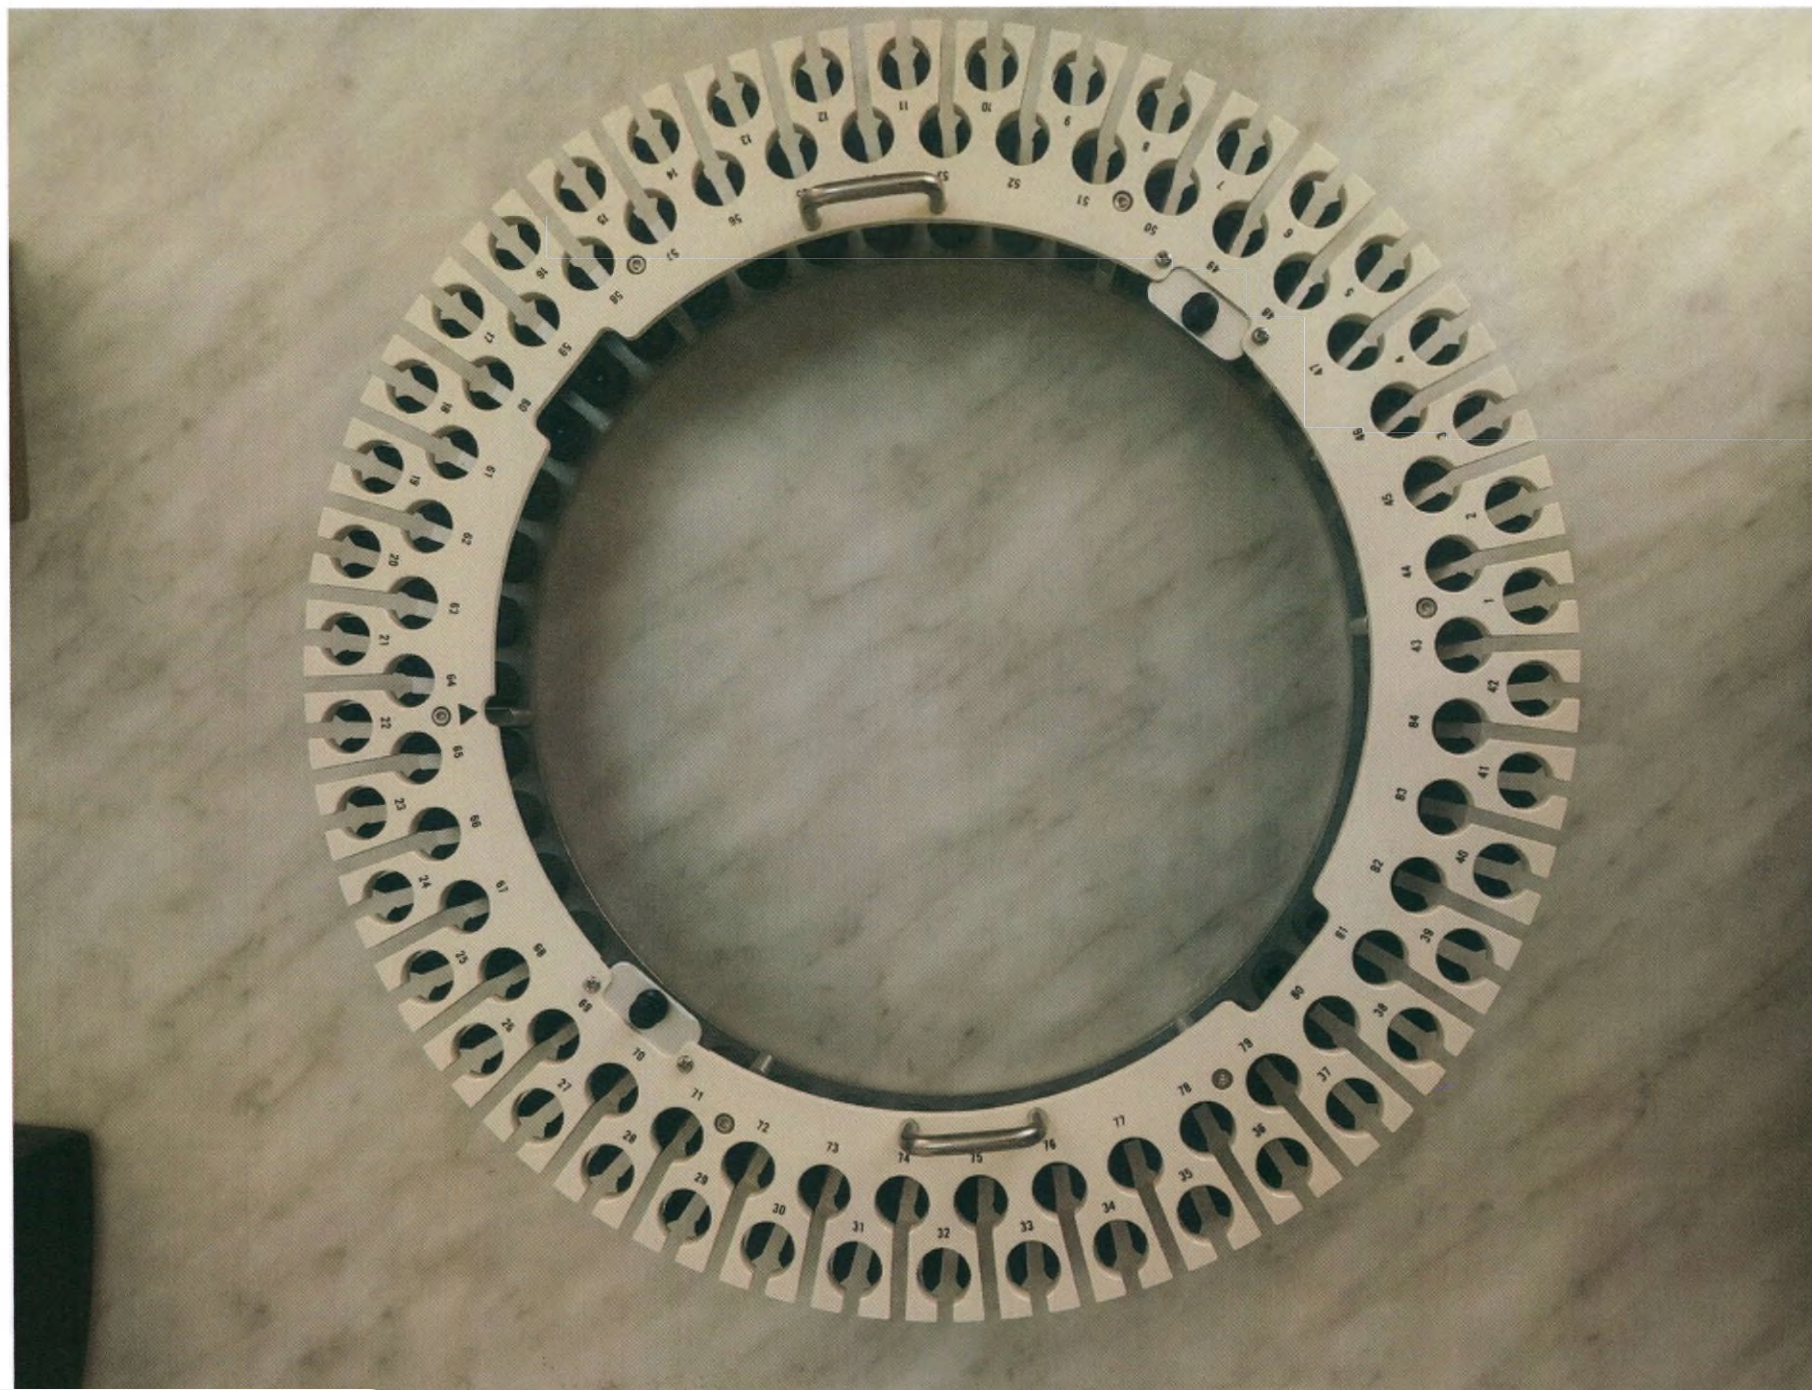

40. Ротор охлаждаемый для проб (Refrigerated sample tray)

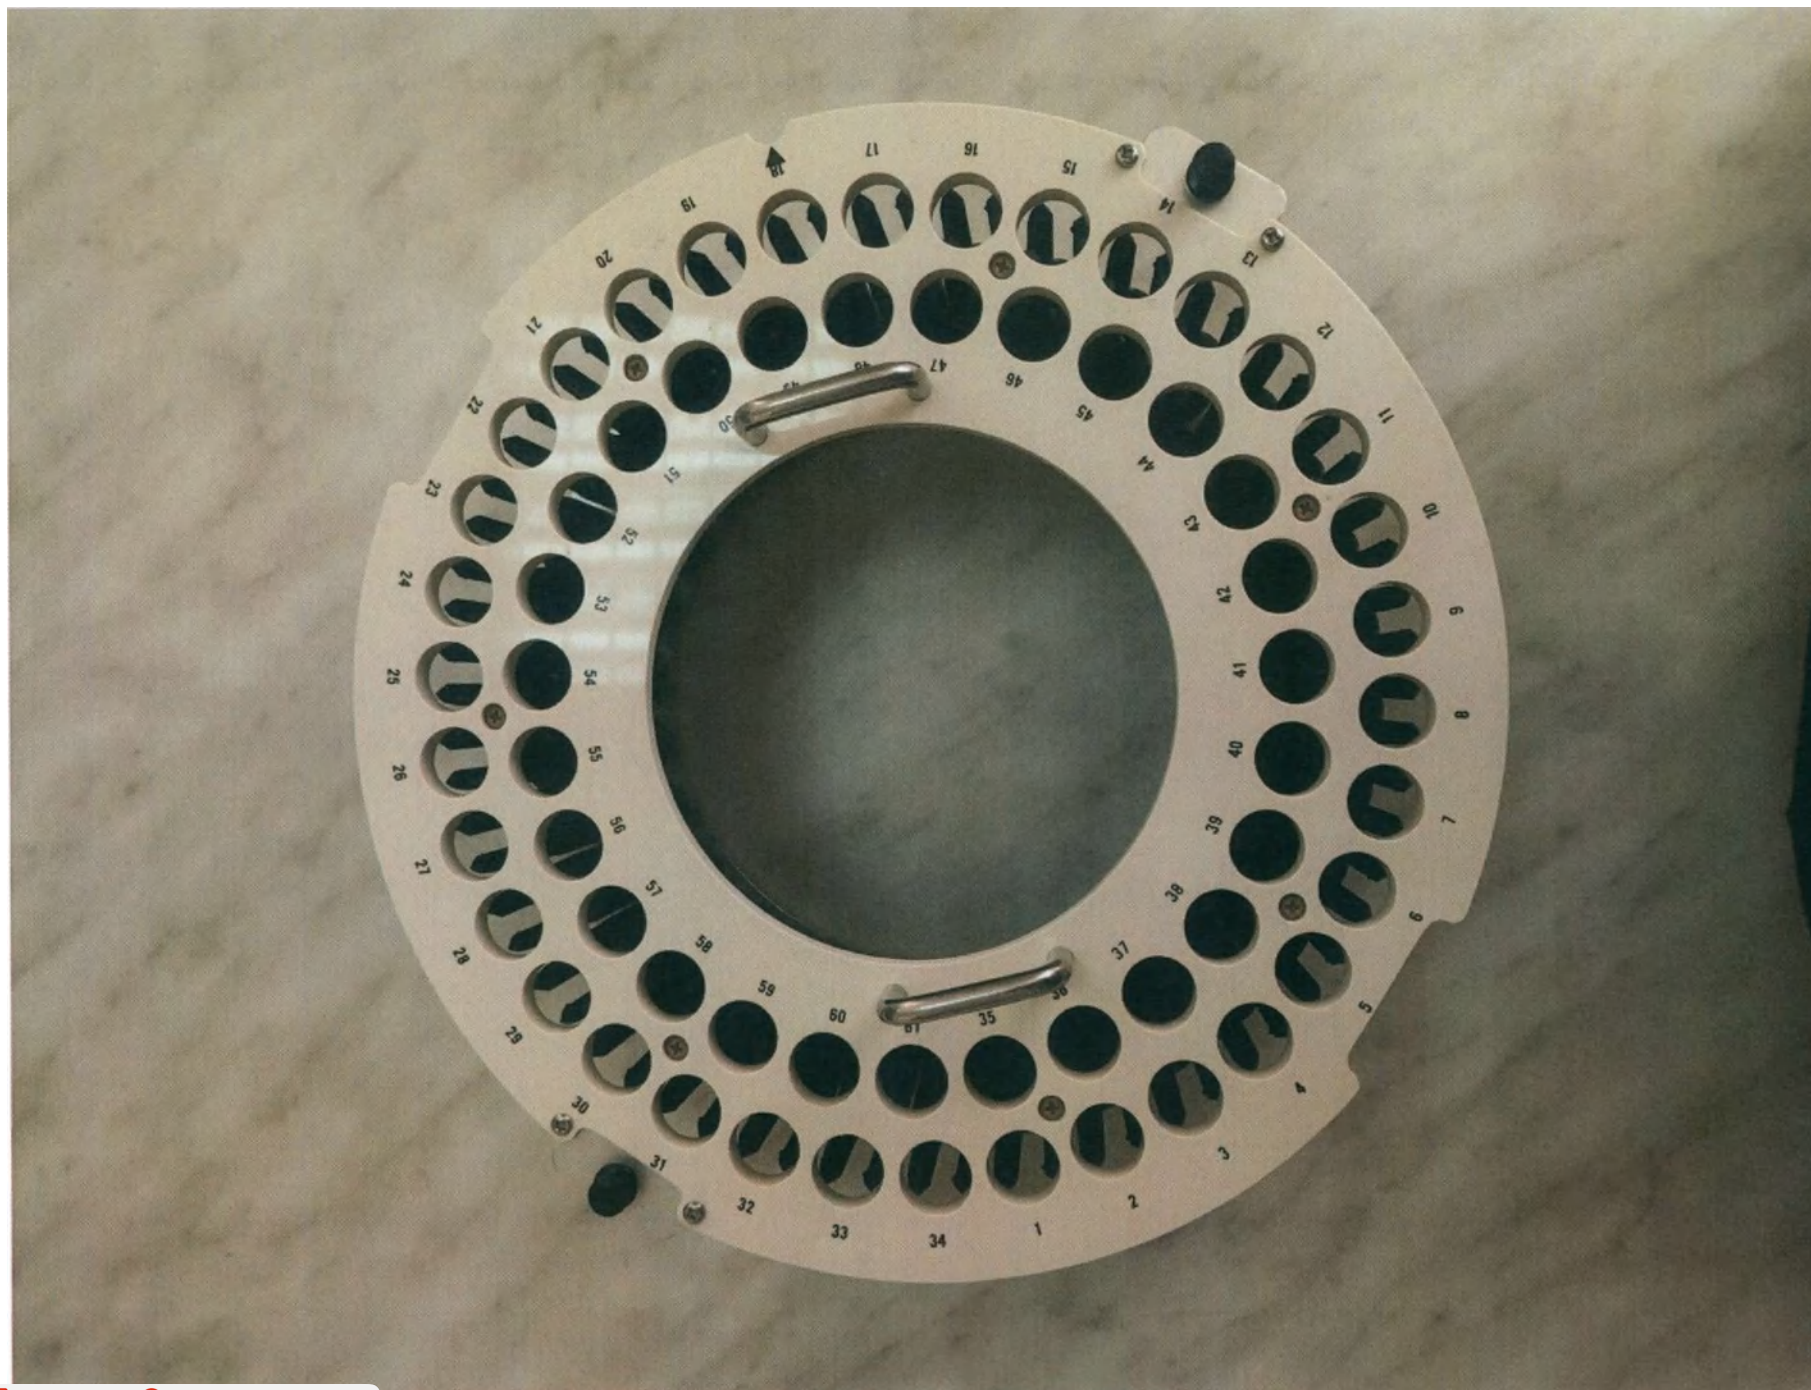

41. Трубка армированная для подключения чистой воды - 10 м (Braided hose tube - 10 m)



42. Трубка армированная для слива отходов - 1м (Braided hose - 1 m)




43. Трубка полиуретановая для слива жидкости из насоса - 10м (Tubing - 10 m)



44. Трубка силиконовая для слива жидкости из коллектора отходов - 1м (Silicone tube - 1 m)



45. Трубка силиконовая для отвода жидкости из моющей станции кювет - 1 м (Silicone tube -1 m)

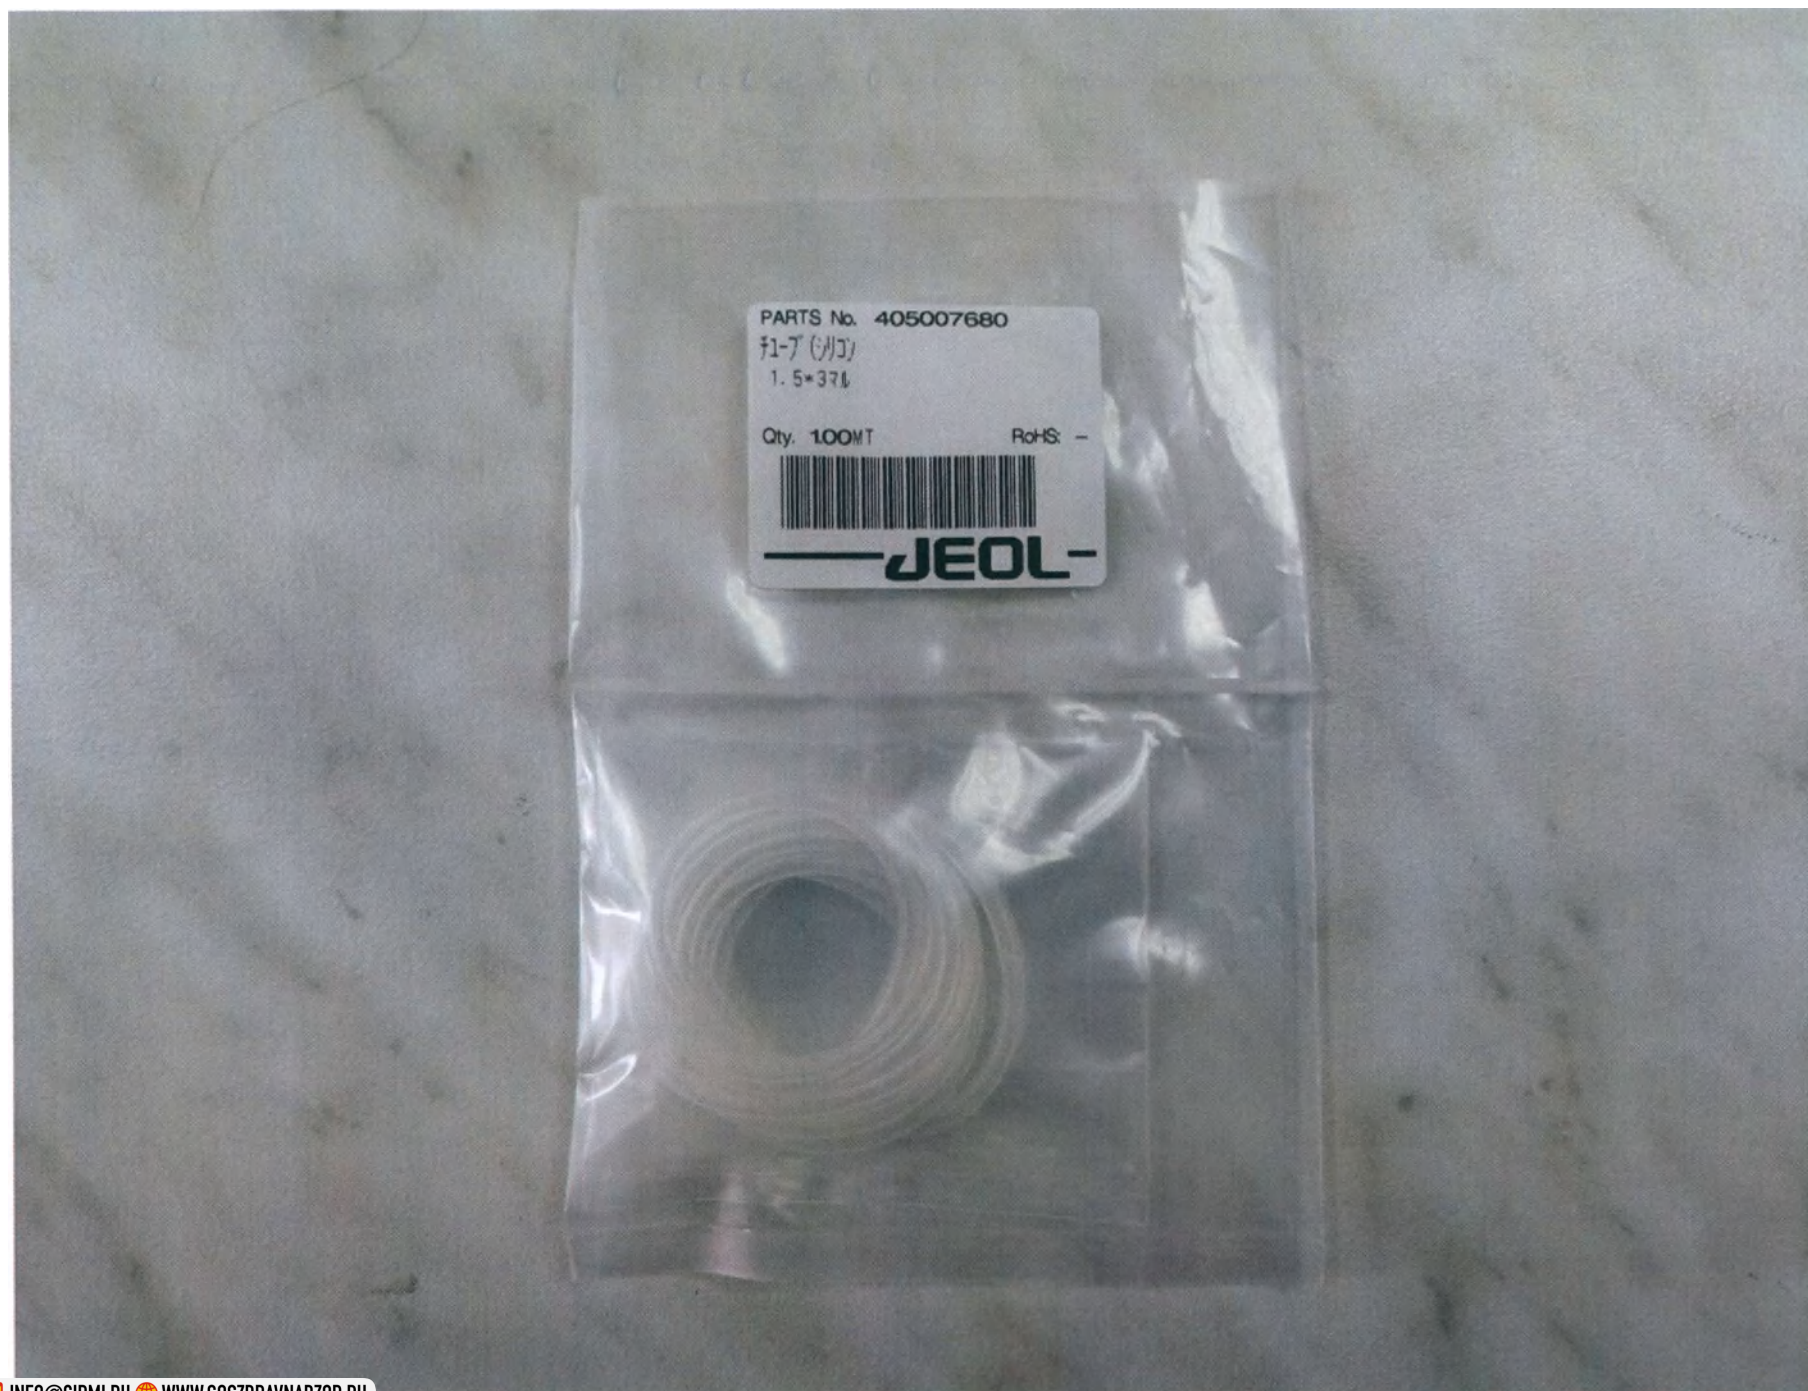

46. Трубка полиуретановая для подключения системы распределения чистой воды - 1 м (Blue tube - 1m)



47. Трубка силиконовая - 1м (Medical silicone tube - 1 m)




48. Переходник для подключения чистой воды (Stop connector)



49. Поддон защиты от перелива (VAT)



50. Емкость с адаптером (Tank)

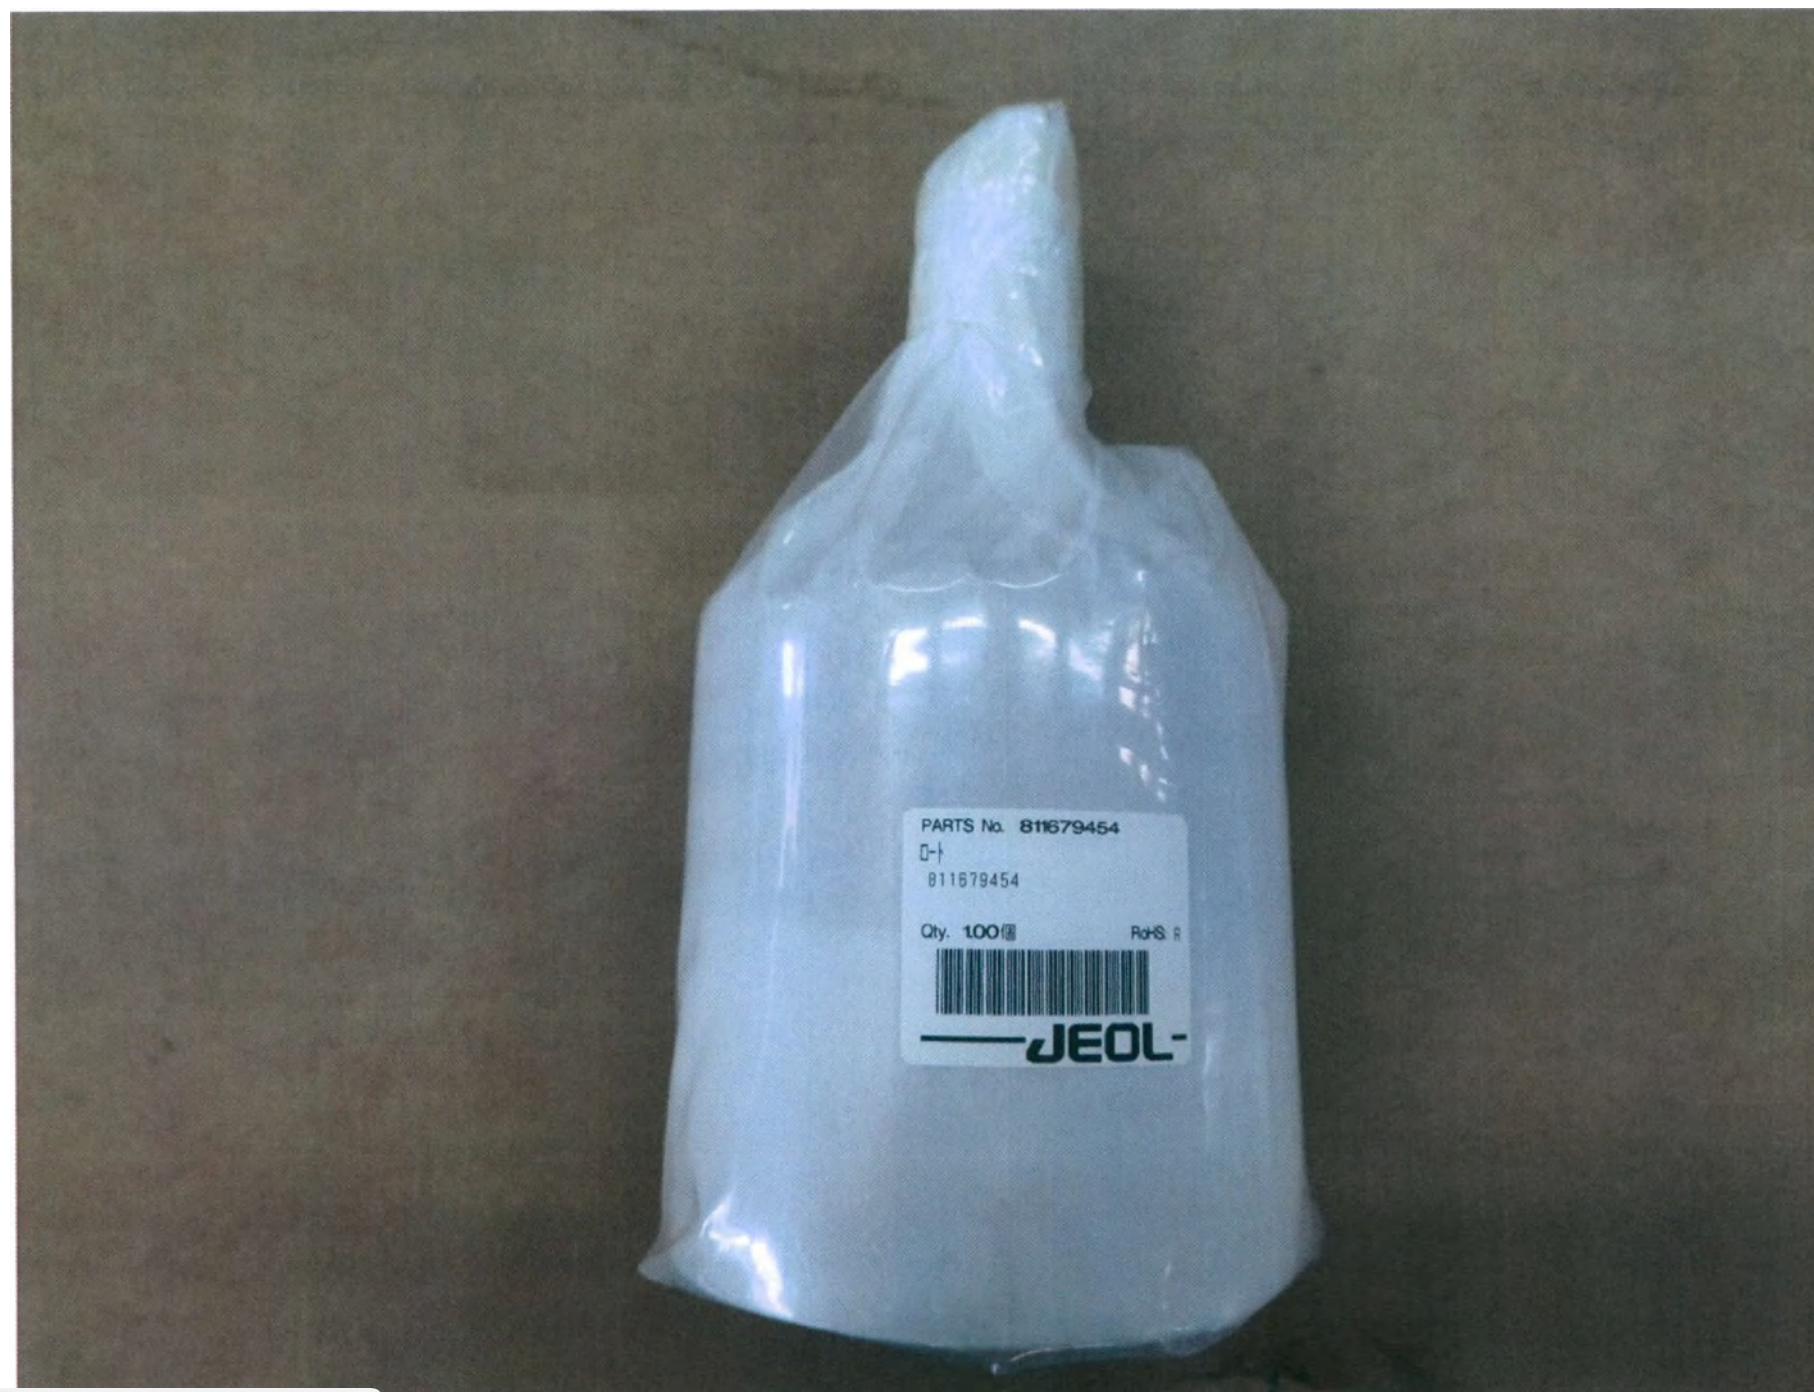


Емкость с адаптером (Tank)



51. Игла дозатора реагентов (Sample tube (RPP))




52. Игла дозатора проб для измерения гликозилированного гемоглобина (Sample tube (#3A1C))

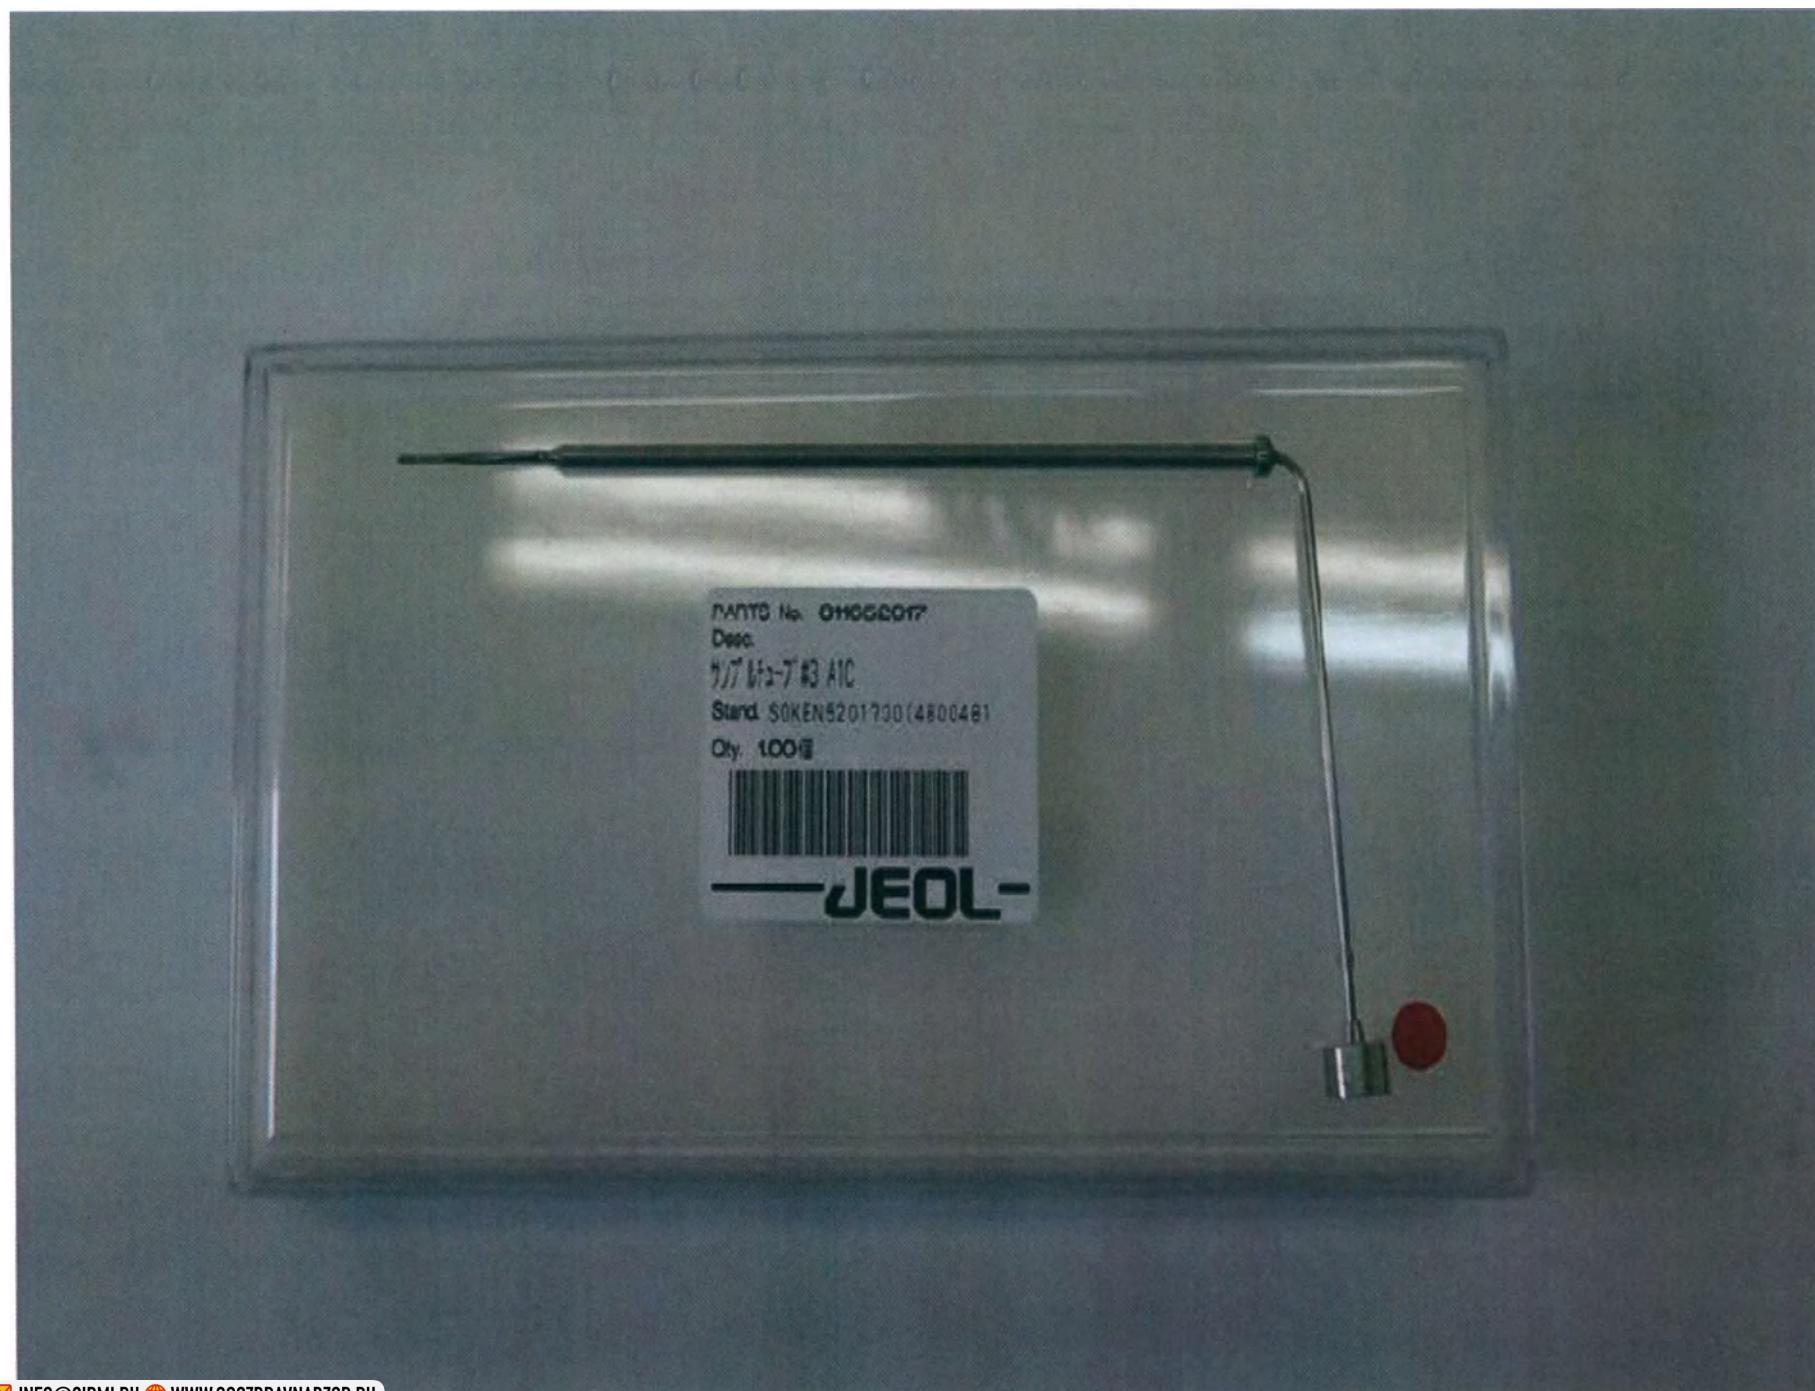

53. Лопатка миксера (Mix shaft (RRV))



54. Кюветы реакционные 21- секционные (RRV Cell)- 11 шт.

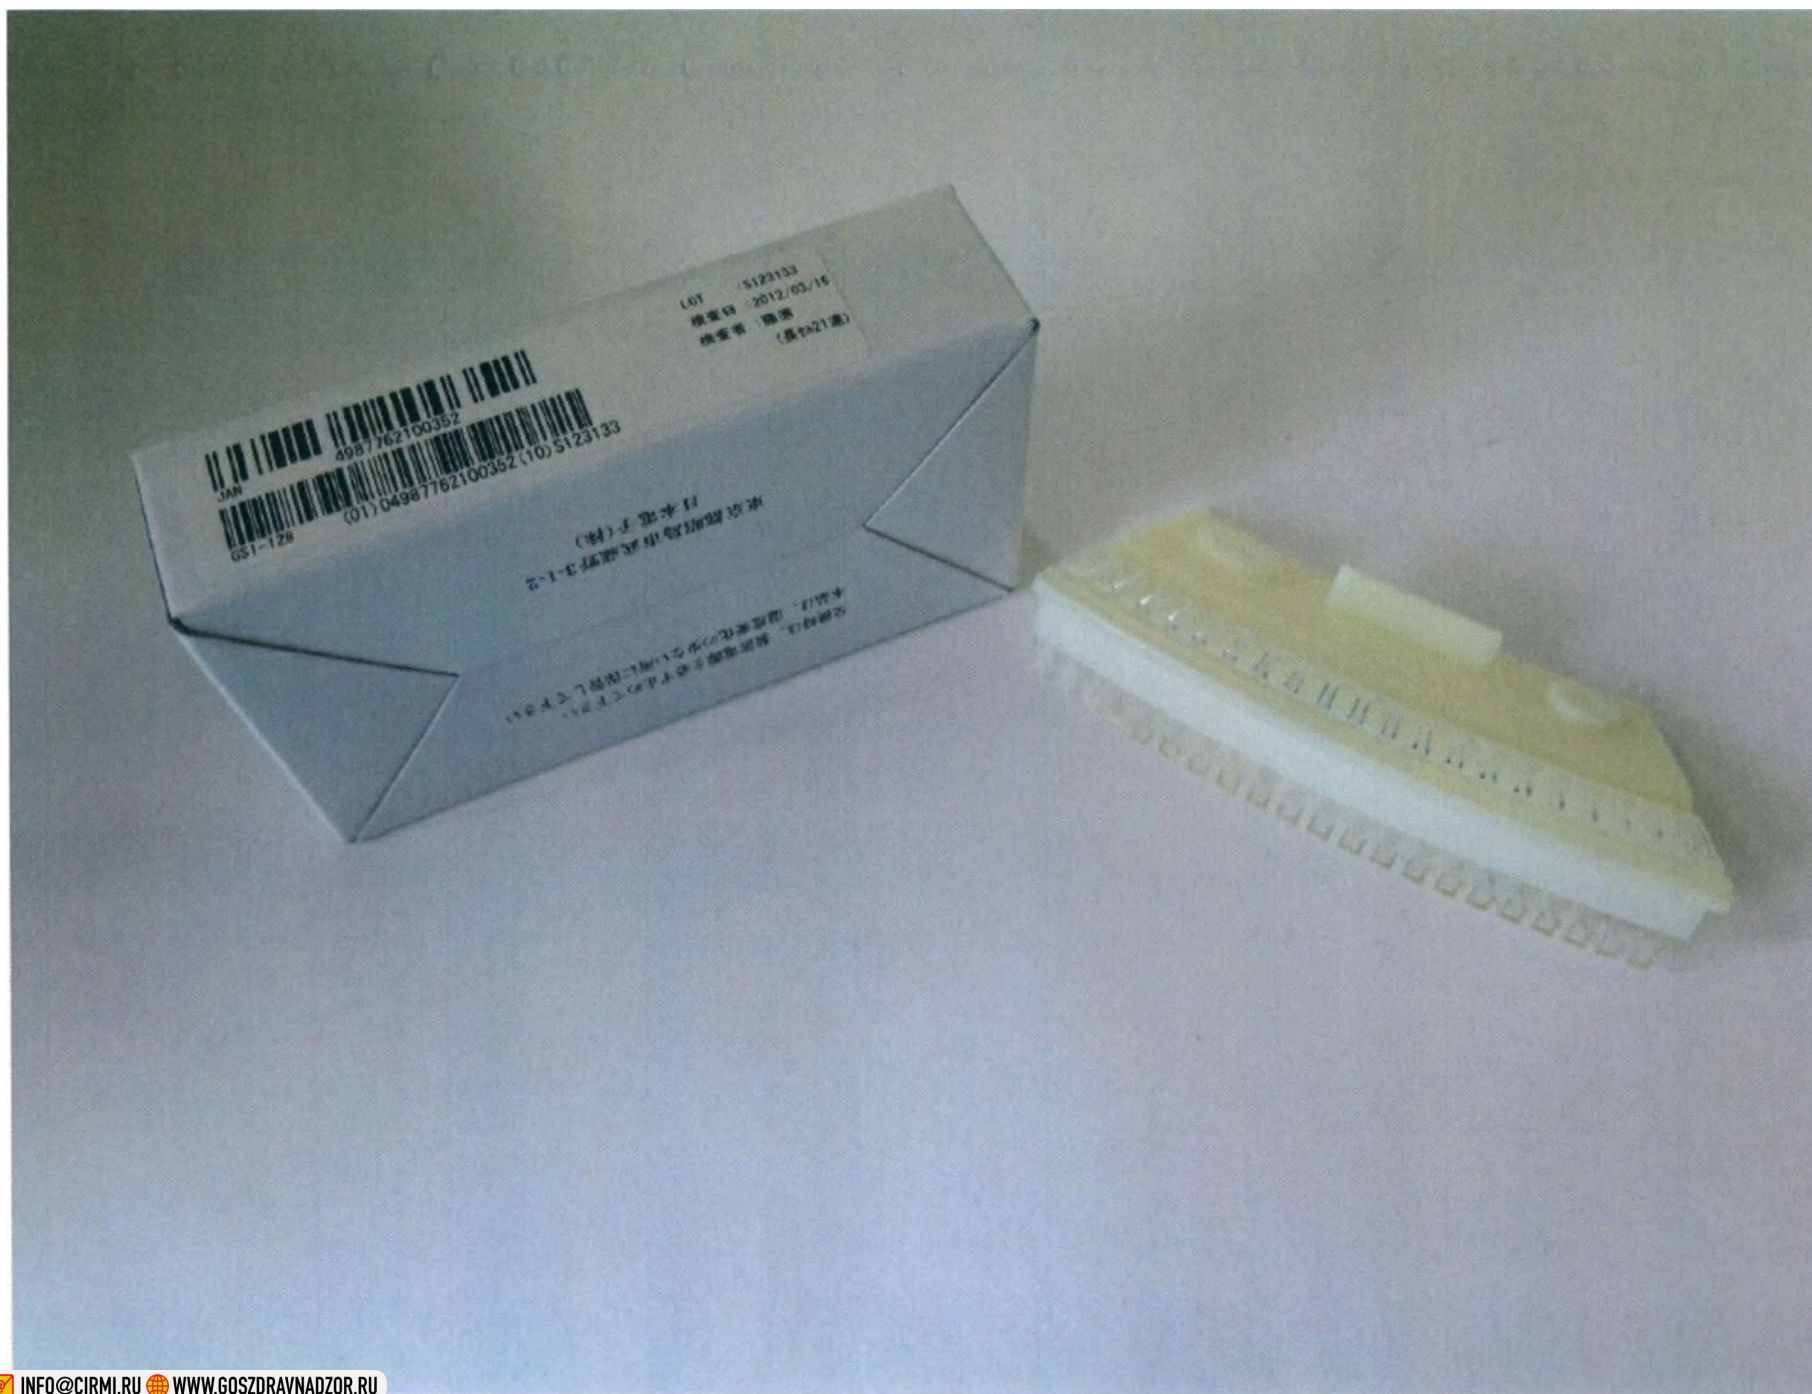

55. Кольцо уплотнительное насоса 1 мм (Pump seal, 1 mm) - не более 4 шт.



56. Кольцо уплотнительное 5 мм (Pump seal, 5 mm) - не более 4 шт.



57. Кольцо уплотнительное 14 мм (Pump seal, 14 mm) - не более 4 шт.



58. Оправки для установки уплотнительных колец насосов (Jig holder) - не более 7 шт.



59. Лампа галогенная для фотометрического модуля (Halogen lamp)



60. Чашка для образцов тип В (Sample cup B type) – не более 1000 шт.



61. Вставка для образцов (Guide sample cup) – не более 100 шт



62. Флакон для реагентов 70 мл. (Reagent bottle, 70ml.) – не более 100 шт.



63. Флакон для реагентов 40 мл. (Reagent bottle, 40ml.) – не более 100 шт.



64. Вставка для флакона 20 мл. в позицию 40 мл. (Tray (40ml 20ml)) – не более 100 шт.



65. Пробирки для проб (Test tube) – не более 100 шт.



66. Набор соединителей для трубок (Joint Kit): -наконечник трубки диаметром 1 мм; -наконечник трубки диаметром 4 мм; -наконечник трубки диаметром 6,5 мм;



67. Нить пластиковая для прочистки игл дозаторов 10м



68. Плата контроля спящего режима (Sleep ITF)



69. Держатель пробирок на ротор проб (Holder) – не более 20 шт.



70. Раствор охлаждения отсека реагентов (Antifreeze bottle)



70. Набор инструментов в контейнере для ввода прибора в эксплуатацию (Tool Box):-Штырь для установки ротора (Rod);-Плоскогубцы (Plier);-Длинногубцы (Long nose pinchers);-Отвертка (Stubby driver(+));-Отвертка крестовая (Stubby driver(+));-Отвертка плоская (Screwdriver(-));-Набор шестигранных ключей (Hexagonal Set).



В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью

73 (сорок три) листов.

Генеральный директор
АО «ДИАКОН»

Иванов А.В.





Генеральный директор

АО «ДИАКОН»

А.В. Иванов

2022г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор автоматический биохимический BioMajesty, в вариантах исполнения JCA-BM6010/C (AUTOMATIC ANALYZER JCA-BM 6010/C), BM6070/C (AUTOMATIC ANALYZER JCA-BM 6070/C)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

JEOL Ltd., Япония

**вариант исполнения BioMajesty JCA-BM6070/C
(AUTOMATIC ANALYZER JCA-BM 6070/C)**

Анализатор автоматический биохимический BioMajesty JCA-BM6070/C (AUTOMATIC ANALYZER JCA-BM 6070/C), в составе:

1. Основной модуль анализатора (MAIN CONSOLE (JCA-BM6070/C AUTOMATIC ANALYZER CA-20241BM607C)) – 1 шт.
2. Панель управления (BM6070C LOGO CV) -1 шт.
3. Набор CD-дисков восстановления системы (SYSTEM BACKUP DISC#1 SYSTEM PARAMETER#2 SYSTEM PARAMETER) – 1 набор в составе:
 - №1 Параметры системы - 1 шт.
 - №2 Параметры системы - 1 шт.
4. Крышка модуля разбавления (DPP) (INNER COVER (DPP)) – 1 шт. (при необходимости)
5. Емкость для масла инкубационной ванны (BOTTLE (INCUBATION BATH OIL)) – 1 шт. (при необходимости)
6. Емкость для кондиционера кювет (BOTTLE (CUVETTE CONDITIOINER)) – 1 шт. (при необходимости)
7. Емкость для раствора промывающего №3 для кювет (BOTTLE (CUVETTE WASH SOLUTION)) -1 шт. (при необходимости)
8. Емкость для изотонического солевого раствора (BOTTLE (ISOTONIC SALINE)) – 1 шт. (при необходимости)
9. Емкость для деионизованной воды (BOTTLE DEIONIZED WATER) – 1 шт. (при необходимости)
10. Ротор калибраторов и контролей (CTT) (CTT TRAY) -1 шт. (при необходимости)
11. Ротор для образцов (STT) (STT TRAY) -1 шт. (при необходимости)
12. Коробка (ACSRV BM6070C-A with List) – 1 шт.
13. Ящик с инструментами (TOOL BOX) – 1 шт.
14. Имбусовые ключи (6 шт. / набор) (ALLEN KEY) -1 набор.
15. Короткая крестовая отвертка (STUBBY SCREWDRIVER(PH2)) – 1 шт.
16. Длинногубцы (RADIO PINCHERS) – 1 шт.
17. Плоскогубцы с шарниром (PLIERS) -1 шт.
18. Крестовая отвертка (SCREW DRIVER(+)) – 1 шт.
19. Стоп-коннектор (STOP CONNECTOR) - 1 шт.
20. Переходник быстросъемный (LWP SOCKET) (JIG(LWP SOCKET)) – 1 шт.
21. Переходник угловой LWP(PLUG) (JIG LWP(PLUG)) – 1 шт.
22. Нейлоновая трубка 2 м. (NYLON TUBE 2m) – 1 шт.
23. Армированный шланг диаметр 25 мм.; 1 м (BRAIDED HOSE 1m) -1 шт.
24. Армированный шланг диаметр 12 мм.; 6 м (TETORON BRAIDED-H 12*18 6m) - 1шт.
25. Флакон 70 мл. (REAGENT BOTTLE 70ML) - 10 шт. (при необходимости)
26. Нейлоновая трубка 4/6 (Зелёная) 2м (Nylon Tube 4/6 (Green) 2m) – 1 шт.
27. Галогенная лампа (HALOGEN LAMP#5) - не более 6 шт. (при необходимости)
28. Пробирка (TUBE) - 10 шт. (при необходимости)
29. Сетчатый фильтр (MESH FILTER (STRAINER)) – 1 шт. (при необходимости)
30. Чашка для образцов (5 уп. / 100 шт. в наборе) (SAMPLE CUP 100/pkg) - 1 набор. (при необходимости)
31. Адаптер для чашек образцов 50 шт. / набор (GUIDE (SAMPLE CUP) 50/pkg) – 1 набор. (при необходимости)
32. Трубка для охлаждающей жидкости 1м. (TUBE(JIG, TUBING FOR CHILLER 1m)) – 1 шт.
33. Воронка (FUNNEL) – 1 шт.


34. Флакон для реагентов 40 мл. (REAGENT BOTTLE 40ML) – 5 шт. (при необходимости)
35. Переходник 40 мл х 70 мл (HOLDER) - 10 шт. (при необходимости)
36. Переходник 20 мл х 40 мл (TRAY) – 10 шт. (при необходимости)
37. Переходник 20 мл х 70 мл (20ML HOLDER) – 20 шт. (при необходимости)
38. Раствор охлаждения отсека реагентов 2 кг. (C.C.COOLANT 2KG) – 1 шт. (при необходимости)
39. Ключ замка модуля разбавления (DPP) KEY (DPP) – 2 шт.
40. Петля замка (DPP) U-образная (HINGE (U-shape)) – 1 шт.
41. Петля замка (DPP) V-образная (HINGE (v-shape)) – 1 шт.
42. Винты (4 мм х12 мм) для фиксации U-образной петли (SCREW (4x12)) – 4 шт.
43. Ключ замка модуля дозирования образцов (SPP) (KEY (SPP)) – 2 шт.
44. Винт (4 мм х12 мм) для фиксации V-образной петли (HEX SCREW (4x12)) – 4 шт.
45. Крышка электродов ISE (ISE COVER) – 1 шт. (при необходимости)
46. Набор фиксации крышки ISE (SCREWS AND O-RING (3 SCREWS, 1 O-RING))– 1 набор в составе (при необходимости):
 - винт – 3 шт.
 - уплотнительное кольцо – 1 шт.
47. Панель фиксации монитора (SPACER) – 1 шт.
48. Имбусовые винты (4 мм х 8 мм) (HEX SCREW (4x8)) – 4 шт.
49. Уплотнительная лента (SILICONE RUBBER TAPE) - 1 шт.
50. Ротор реагентов (RTT1) (RTT1 TRAY) – 1 шт. (при необходимости)
51. Ротор реагентов (RTT2) (RTT2 TRAY) – 1 шт. (при необходимости)
52. Крышка модуля дозирования образцов (SPP) (INNER COVER (SPP)) – 1 шт. (при необходимости)
53. Крышка ротора калибраторов и контролей (CTT) (CTT COVER) - 1 шт. (при необходимости)
54. Крышка ротора образцов (STT) (STT COVER) – 1 шт. (при необходимости)
55. Пластиковая крышка для защиты от брызг (STT/CTT) (SPLASH-PROOF COVER(STT/CTT)) – 1 шт. (при необходимости)
56. Пластиковая крышка для защиты от брызг (RPP1) (SPLASH-PROOF COVER(RPP1)) – 1 шт. (при необходимости)
57. Пластиковая крышка для защиты от брызг (RPP2) (SPLASH-PROOF COVER(RPP2)) – 1 шт. (при необходимости)
58. Пластиковая крышка для защиты от брызг (SPP) (SPLASH-PROOF COVER(SPP)) – 1 шт. (при необходимости)
59. Пластиковая крышка для защиты от брызг (DPP) (SPLASH-PROOF COVER(DPP)) – 1 шт. (при необходимости)
60. Пластиковая крышка для защиты от брызг (MIX) (SPLASH-PROOF COVER(MIX)) - 1 шт. (при необходимости)
61. Пластиковая крышка для защиты от брызг (ISE) (SPLASH-PROOF COVER(ISE)) - 1 шт. (при необходимости)
62. Крышка ротора реагентов RTT1 (RTT1 COVER) – 1 шт. (при необходимости)
63. Крышка ротора реагентов RTT2 (RTT2 COVER) – 1 шт. (при необходимости)
64. Отчёт о тестировании (PERFORMANCE REPORT) – 1 шт.
65. Руководство по эксплуатации автоматического биохимического анализатора BioMajesty JCA-BM6070/C (INSTRUCTIONS JCA-BM6070/C AUTOMATIC ANALYZER) – 1 шт.
66. Кабель EU 5 м. (POWER CABLE(5M) EU) – 1 шт.
67. Сенсорный монитор (TOUCH PANEL MONITOR) – 1 шт. (при необходимости)

68. Кабель питания (JPN) (POWER CABLE (JPN)) – 1 шт.
69. RGB Кабель (RGB CABLE) – 1 шт.
70. USB Кабель (USB CABLE) – 1 шт.
71. Кабель последовательного порта RS-232C (RS-232C CABLE) – 1 шт.
72. Краткое руководство по установке монитора (QUICK INSTALLATION GUIDE) – 1 шт. (при необходимости)
73. Руководство по эксплуатации монитора на CD-диске (MONITOR INSTRUCTION MANUAL (CD-ROM)) – 1 шт. (при необходимости)
74. Подставка монитора (BOTTOM PLATE) – 1 шт. (при необходимости)
75. Переходник вилки питания 3PIN-2PIN (JPN) (3PIN-2PIN POWER PLUG CONVERSION ADAPTER(JPN)) – 1 шт.
76. Источник Питания AC (AC ADAPTER) – 1 шт. (при необходимости)
77. Имбуксовые винты (4 мм x20 мм) (HEX SCREW(4x20)) - 4 шт.
78. Операционный модуль (OPECON) – 1 шт. (при необходимости)
79. Резиновые ножки для операционного модуля (RUBBER FEET) – 4 шт. (при необходимости)
80. Винт крепления резиновых ножек (SCREW FOR RUBBER FEET) – 4 шт. (при необходимости)
81. Отчёт о проверке (INSPECTION REPORT) – 1 шт.
82. Лицензионные условия использования продуктов Microsoft (MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS(eng)) – 1 шт.
83. Мышь (MOUSE) – 1 шт.
84. Переходник DVI – RGB (VGA-TO-DVI ADAPTER) – 1 шт.
85. Клавиатура (KEYBOARD) – 1 шт. (при необходимости)
86. Индикатор состояния (STATUS LIGHT) -1 шт. (при необходимости)
87. Набор скатов деревянных основного модуля (Ramp Set (1 ramp, 2 foot for ramp)) -1 набор в составе:
 - Рампа - 1 шт.
 - Опоры рамп - 2 шт.
88. Раствор промывающий К для дозатора реагентов (3 фл. / 500 мл. в упаковке) (REAGENT PROBE WASH K) - не более 3х уп. (при необходимости).
89. Раствор промывающий №1 для дозатора реагентов (5 фл. / 250 мл. в упаковке) (REAGENT PROBE WASH 1) - 1 уп. (при необходимости).
90. Раствор промывающий №2 для дозатора реагентов (5 фл. / 250 мл. в упаковке) (REAGENT PROBE WASH 2) - 1 уп. (при необходимости).
91. Раствор охлаждающий для лампы С (400 мл.) (LAMP COOLANT-C) - не более 2 шт. (при необходимости).
92. Раствор промывающий S для дозатора реагентов (500 мл.) (REAGENT PROBE WASH S) – 1 шт. (при необходимости).
93. Раствор промывающий №3 для кювет (2000 мл.) (CUVETTE WASH SOLUTION 3) – не более 40 шт. (при необходимости).
94. Кондиционер №3 для кювет (2000 мл.) (CUVETTE CONDITIONER 3) - не более 20 шт. (при необходимости).
95. Раствор буферный ионоселективного модуля (3000 мл.) (ISE BUFFER) - не более 12 шт. (при необходимости).
96. Калибратор внутреннего расположения (500 мл.) (INTERNAL STANDARD) не более 6 шт. (при необходимости).
97. Комплект калибраторов ионоселективного модуля для сыворотки (ISE SERUM STANDARD SET(NA) – 1 уп. (при необходимости) в составе:
 - Калибратор для сыворотки низкой концентрации 1фл. / 100 мл.;
 - Калибратор для сыворотки высокой концентрации 1фл. / 100 мл.
98. Комплект калибраторов ионоселективного модуля для мочи (ISE URINE STANDARD SET) – 1 уп. (при необходимости) в составе:
 - Калибратор для мочи низкой концентрации 1 фл. / 100 мл.;

- Калибратор для мочи высокой концентрации 1 фл. / 100 мл.
- 99. Раствор промывающий ионоселективного модуля (2 фл. / 100 мл. в упаковке) (ISE DETERGENT SOLUTION) - 1 уп. (при необходимости).
- 100. Электрод ионоселективный натрия (NA ELECTRODE) - не более 3-х шт. (при необходимости)
- 101. Электрод ионоселективный калия (K ELECTRODE) - не более 3-х шт. (при необходимости)
- 102. Электрод ионоселективный хлора (CL ELECTRODE) - не более 3-х шт. (при необходимости)
- 103. Электрод сравнения (REFERENCE ELECTRODE) - не более 3-х шт. (при необходимости)
- 104. Раствор термостатирования реакционных кювет (BM TEST BATH FLUID) - 1 шт. (при необходимости)
- 105. Разбавитель образца (10 фл. / 200 мл. в упаковке) (BM TEST DILUENT) - 1 уп. (при необходимости)
- 106. Раствор термостатирования реакционных кювет FC-43 (3M FLUORINERT FC-43) - 1 шт. (при необходимости)
- 107. Игла дозатора модуля разбавления (DPP) (PROBE(DPP)) - 1 шт. (при необходимости)
- 108. Игла дозатора модуля дозирования образцов (SPP) (PROBE(SPP)) - 1 шт. (при необходимости)
- 109. Игла дозатора модуля дозирования реагентов (RPP) (SAMPLE TUBE RPP #8) - не более 2 шт. (при необходимости)
- 110. Лопатка миксера (MIXER PADDLE) - 1 шт. (при необходимости)
- 111. Мультикюветы реакционные (CUVETTE RRV21) - не более 40 шт. (при необходимости)
- 112. Набор мультикювет ротора разбавления (6 сегментов / уп.) (CUVETTE(DTT MOLDED PKG 6)) - 1 уп. (при необходимости)
- 113. Модуль автоподатчика (MAIN CONSOLE(RACK HANDLER 100 CA-21761RA102)) - 1 шт. (при необходимости)
- 114. Лоток для штативов (RACK TRAY) - 3 шт. (при необходимости)
- 115. Имбусовый винт (M8 x 20 мм) (ALLEN SCREW (M8x20)) - 4 шт. (при необходимости)
- 116. Пружинная шайба (M8) (SPRING WASHER (M8)) - 4 шт. (при необходимости)
- 117. Шайба (M8) (WASHER (M8)) - 4 шт. (при необходимости)
- 118. Руководство по эксплуатации модуля автоподатчика (INSTRUCTIONS CA-21761RA102 Rack handler 100) - 1 шт. (при необходимости)
- 119. Скат деревянный модуля автоподатчика (MAIN CONSOLE CA-21761RA102 RAMP) - 1 шт. (при необходимости)
- 120. Набор штативов для образцов (Sample Rack Set with List) - 1 набор (при необходимости) в составе:
 - Штатив для образцов зеленый - 11 шт.
 - Штатив для образцов голубой - 4 шт.
 - Штатив для образцов серый - 40 шт.
- 121. Панель (panel) - 1 шт (при необходимости)



Рисунок 2

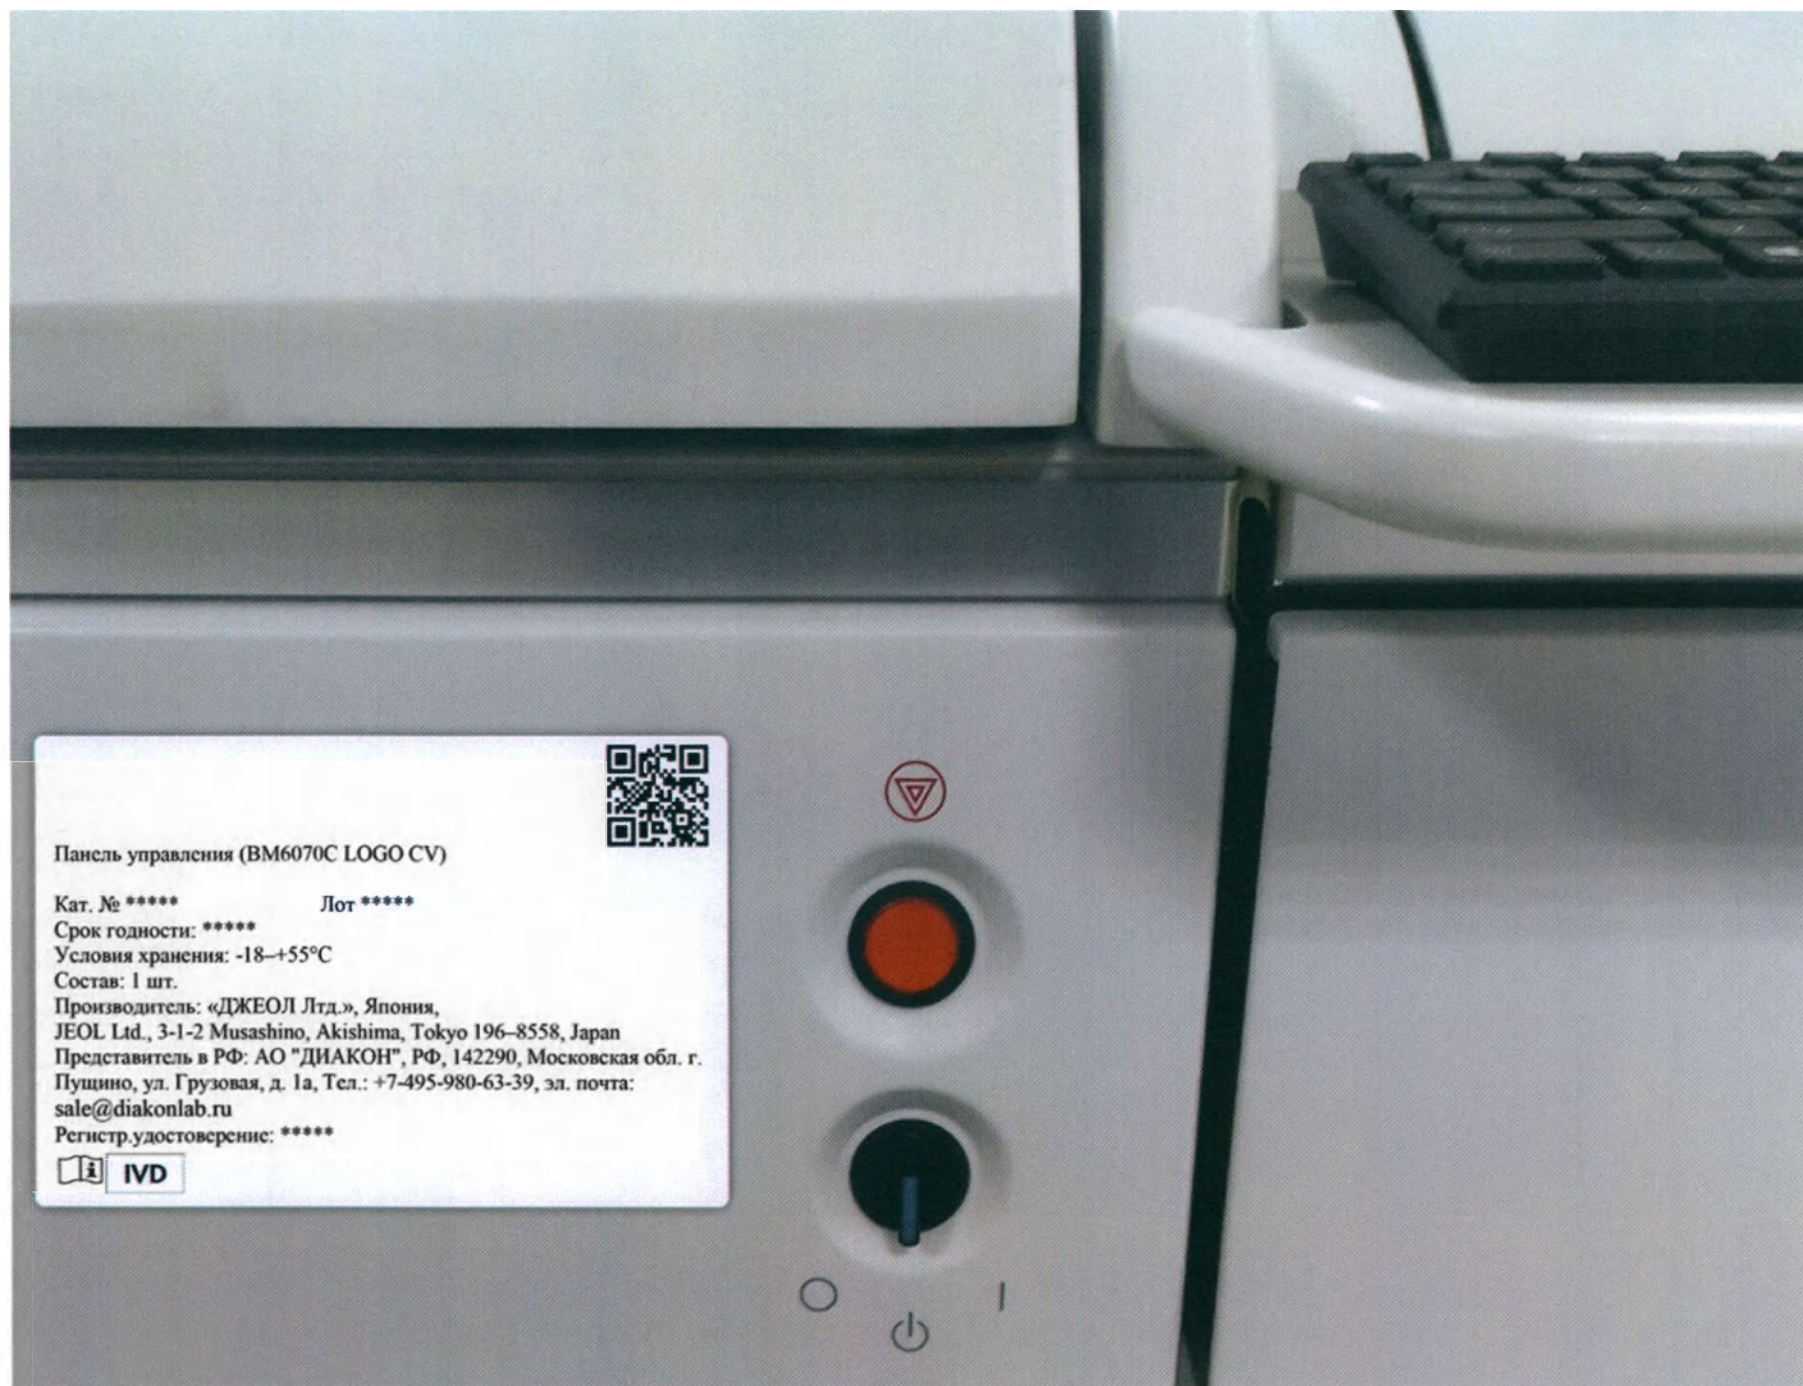

Панель управления (BM6070C LOGO CV)



Кат. № *****

Лот *****

Срок годности: *****

Условия хранения: -18~+55°C

Состав: 1 шт.

Производитель: «ДЖЕОЛ Лтд.», Япония,

JEOL Ltd., 3-1-2 Musashino, Akishima, Tokyo 196-8558, Japan

Представитель в РФ: АО "ДИАКОН", РФ, 142290, Московская обл. г.

Пушино, ул. Грузовая, д. 1а, Тел.: +7-495-980-63-39, эл. почта:

sale@diakonlab.ru

Регистр. удостоверение: *****




Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

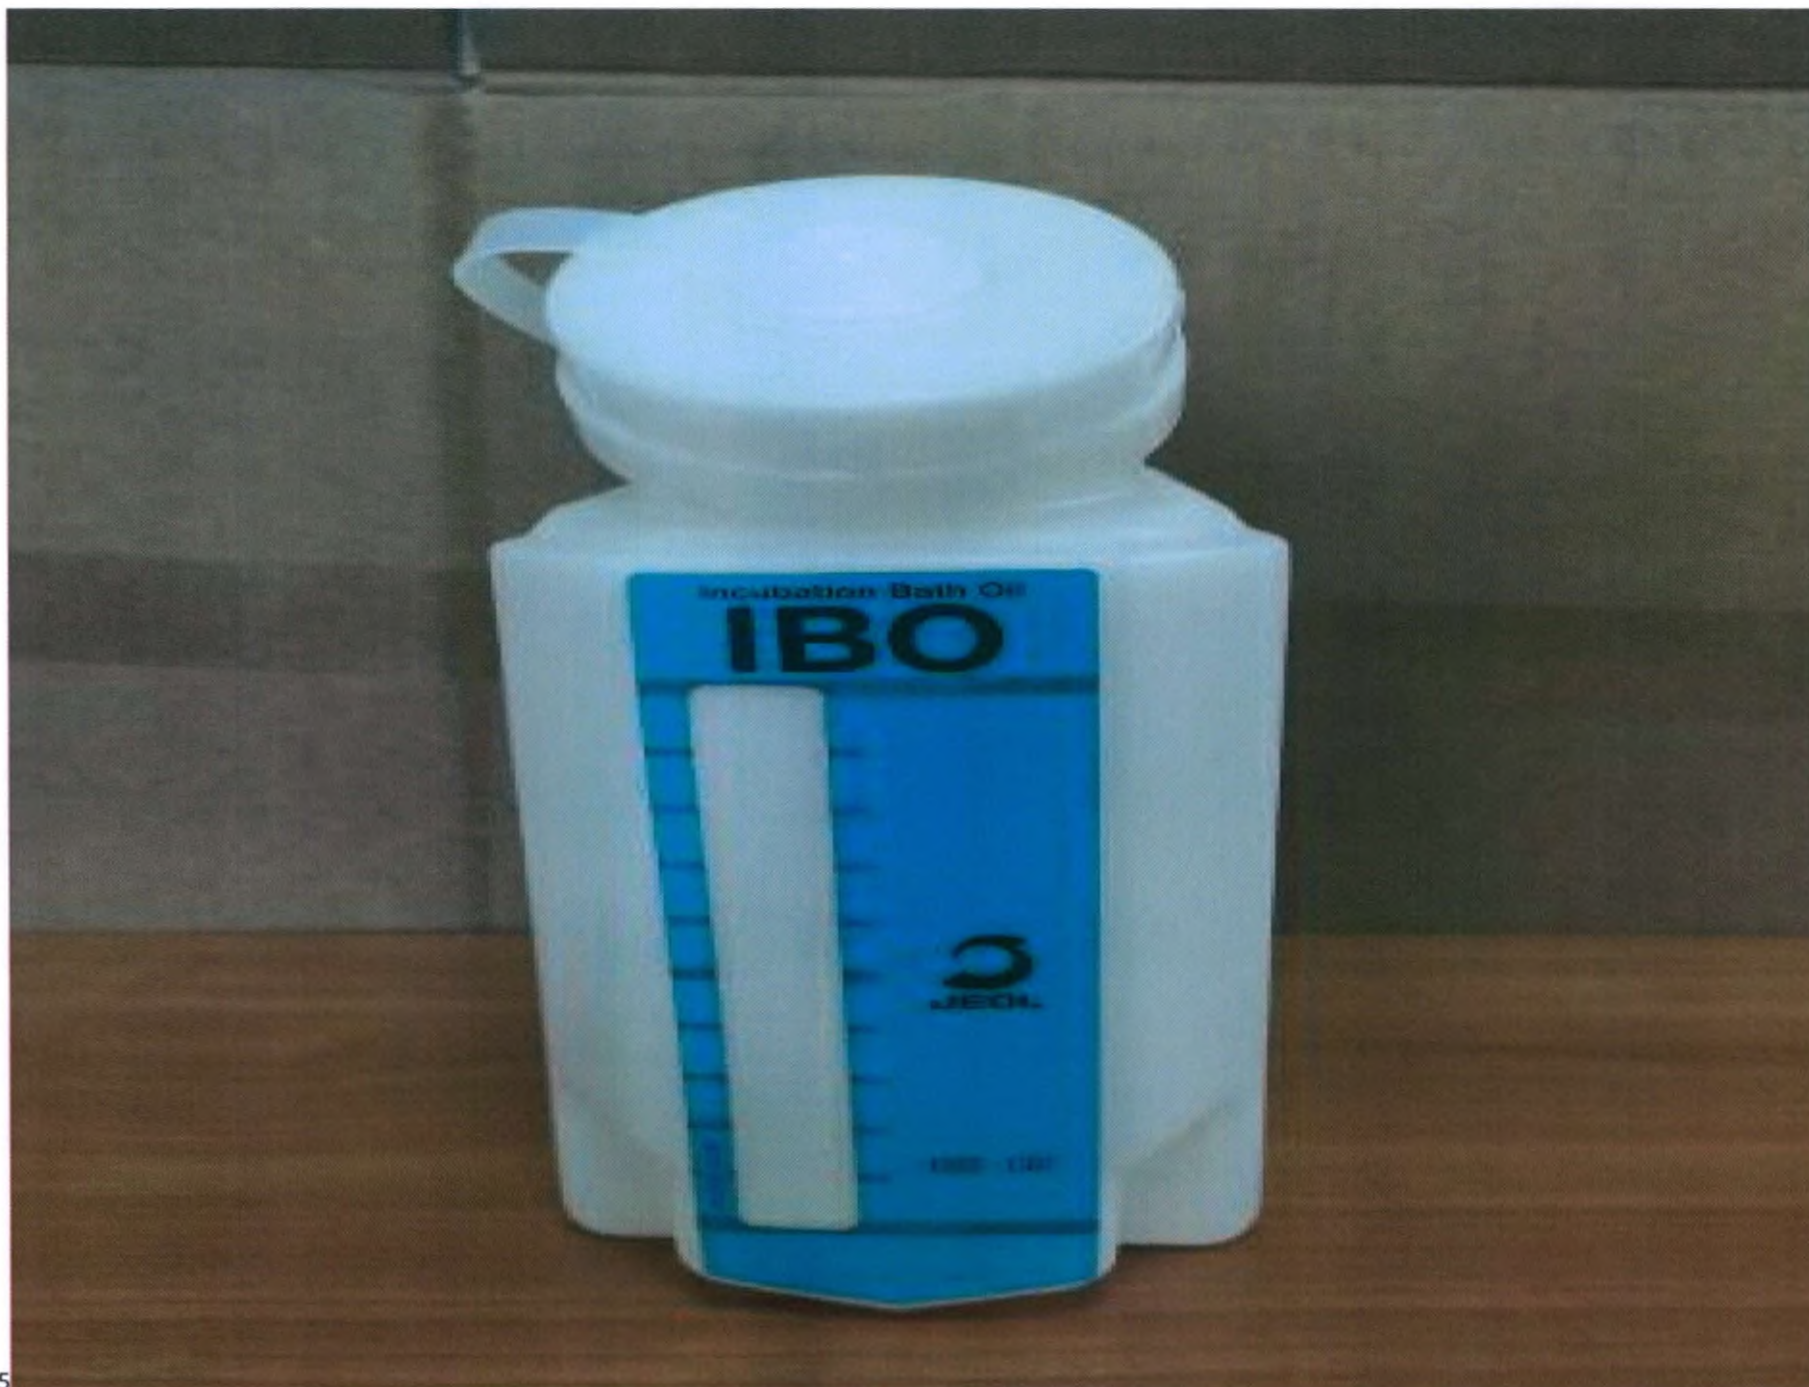


Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8



Рисунок 9

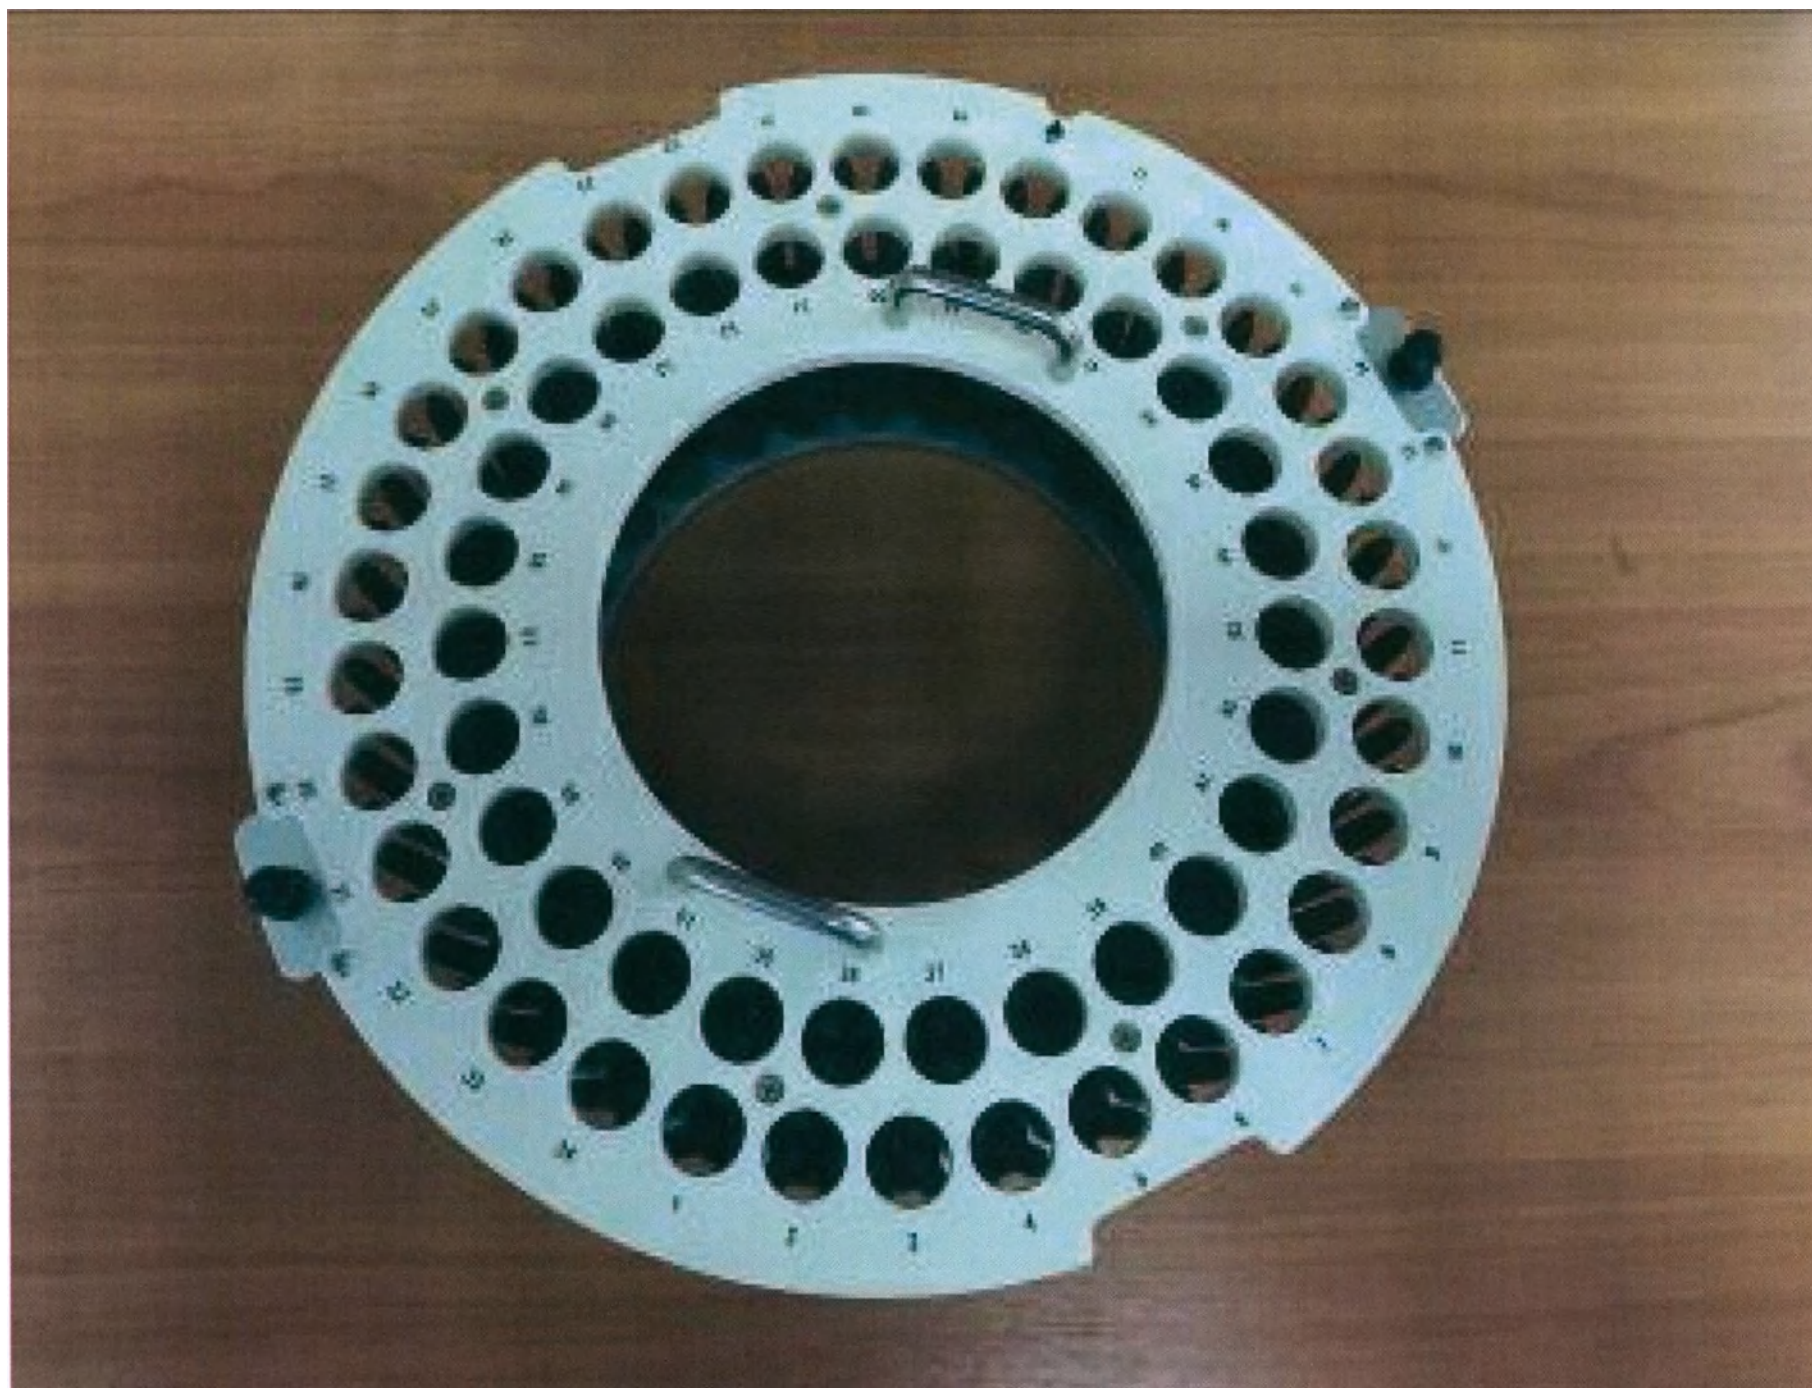


Рисунок 10

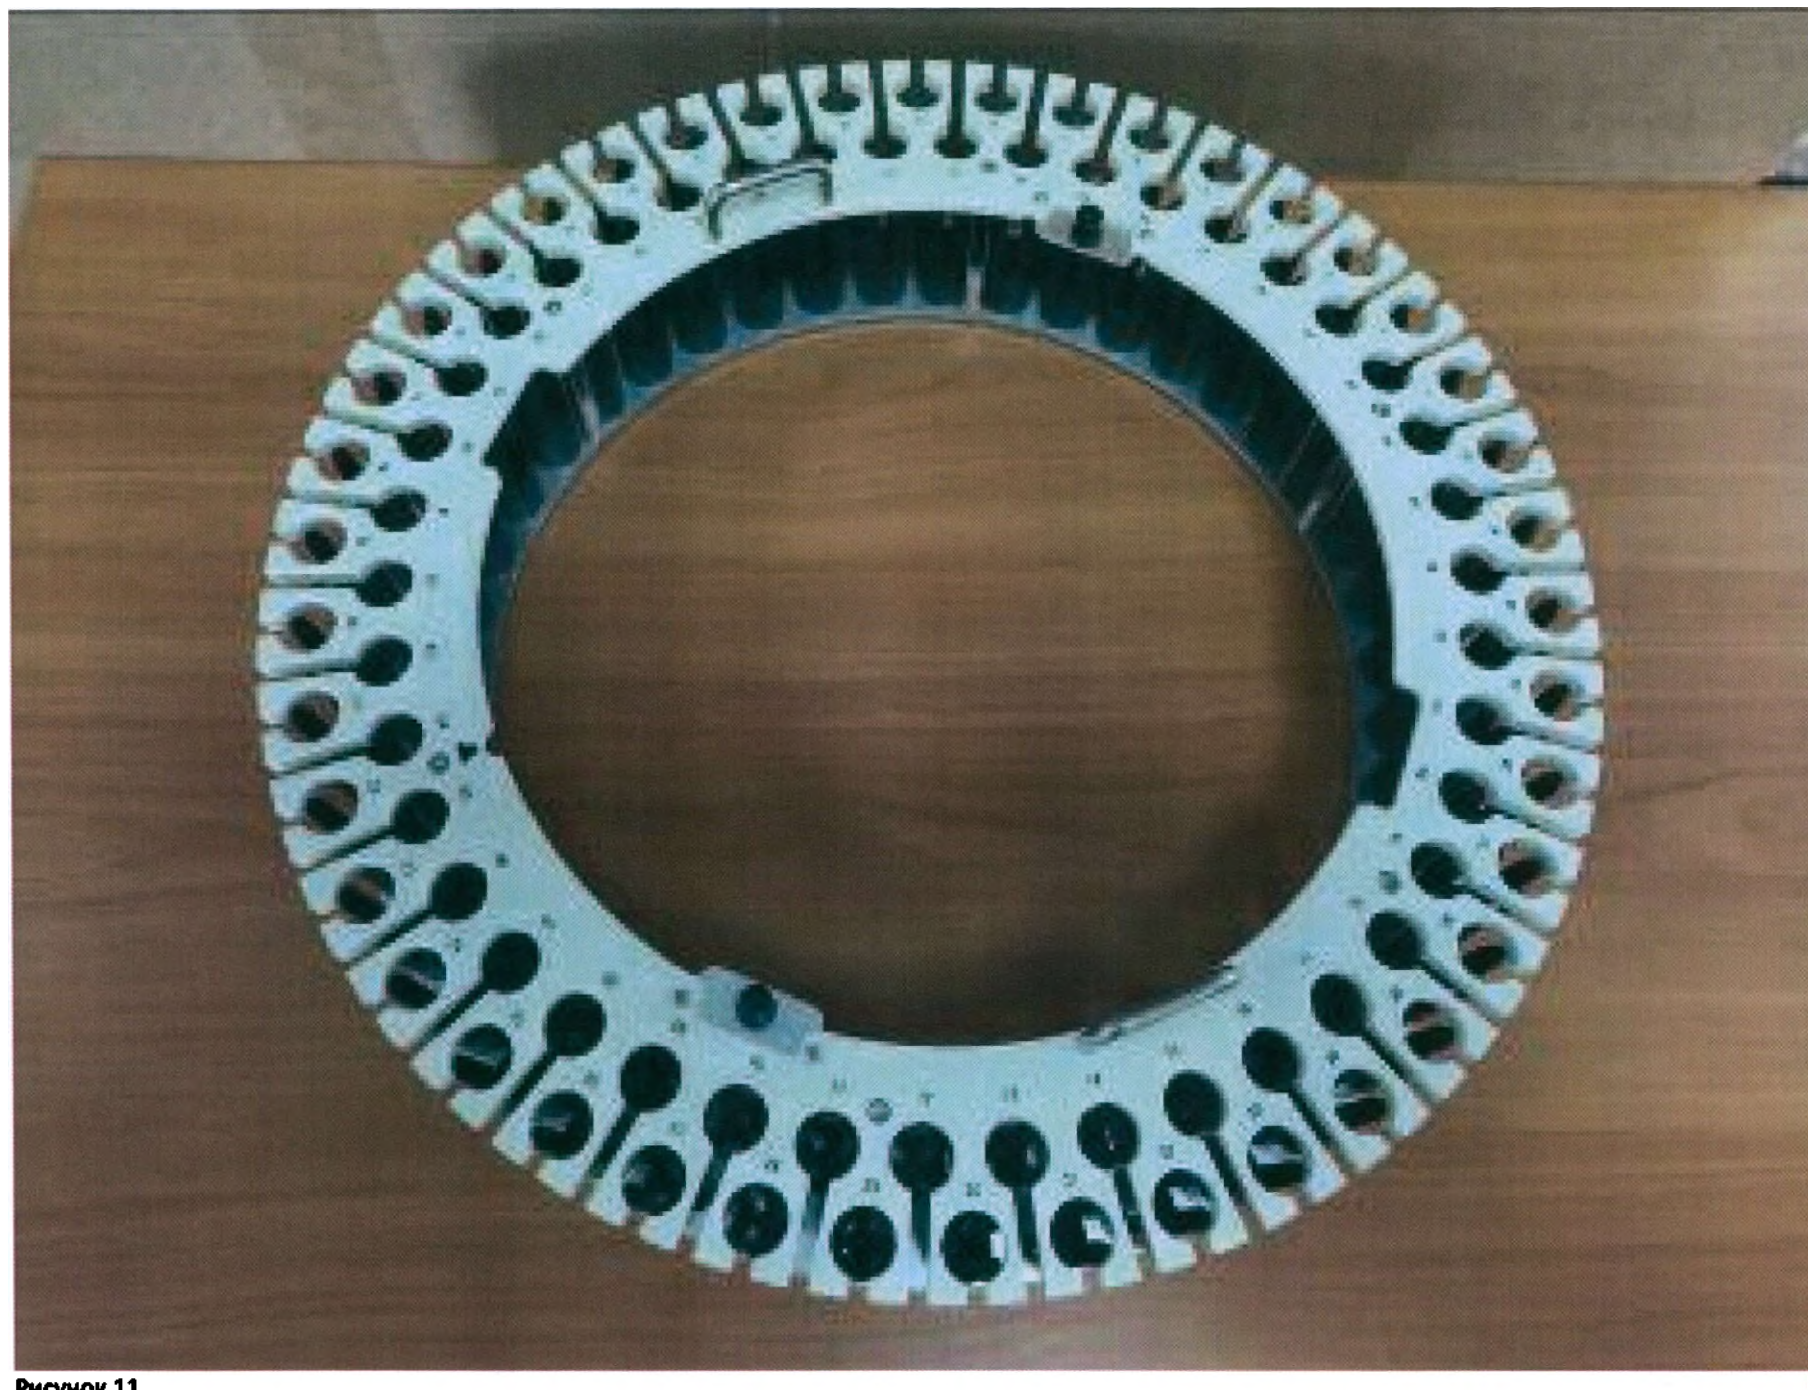


Рисунок 11



Рисунок 12



Рисунок 13



Рисунок 14



Рисунок 14

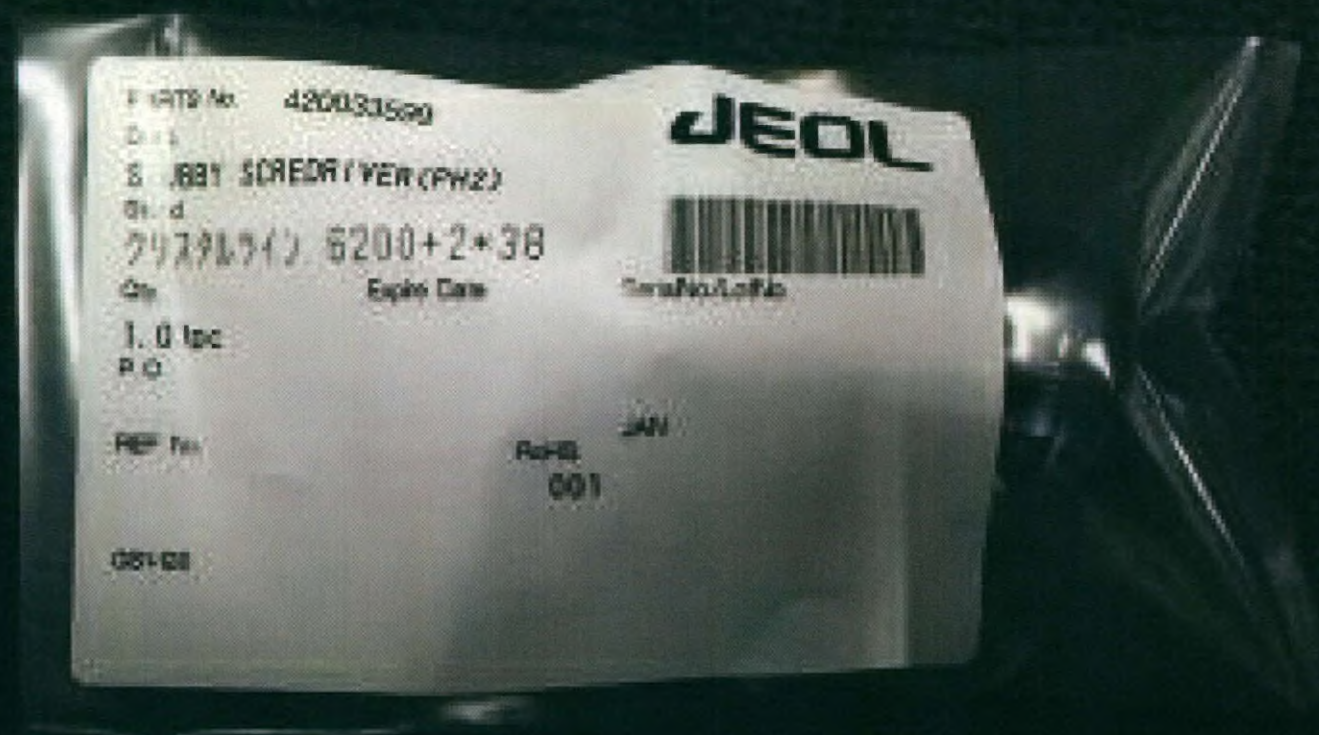


Рисунок 15



Рисунок 15



Рисунок 16



Рисунок 16



Рисунок 17

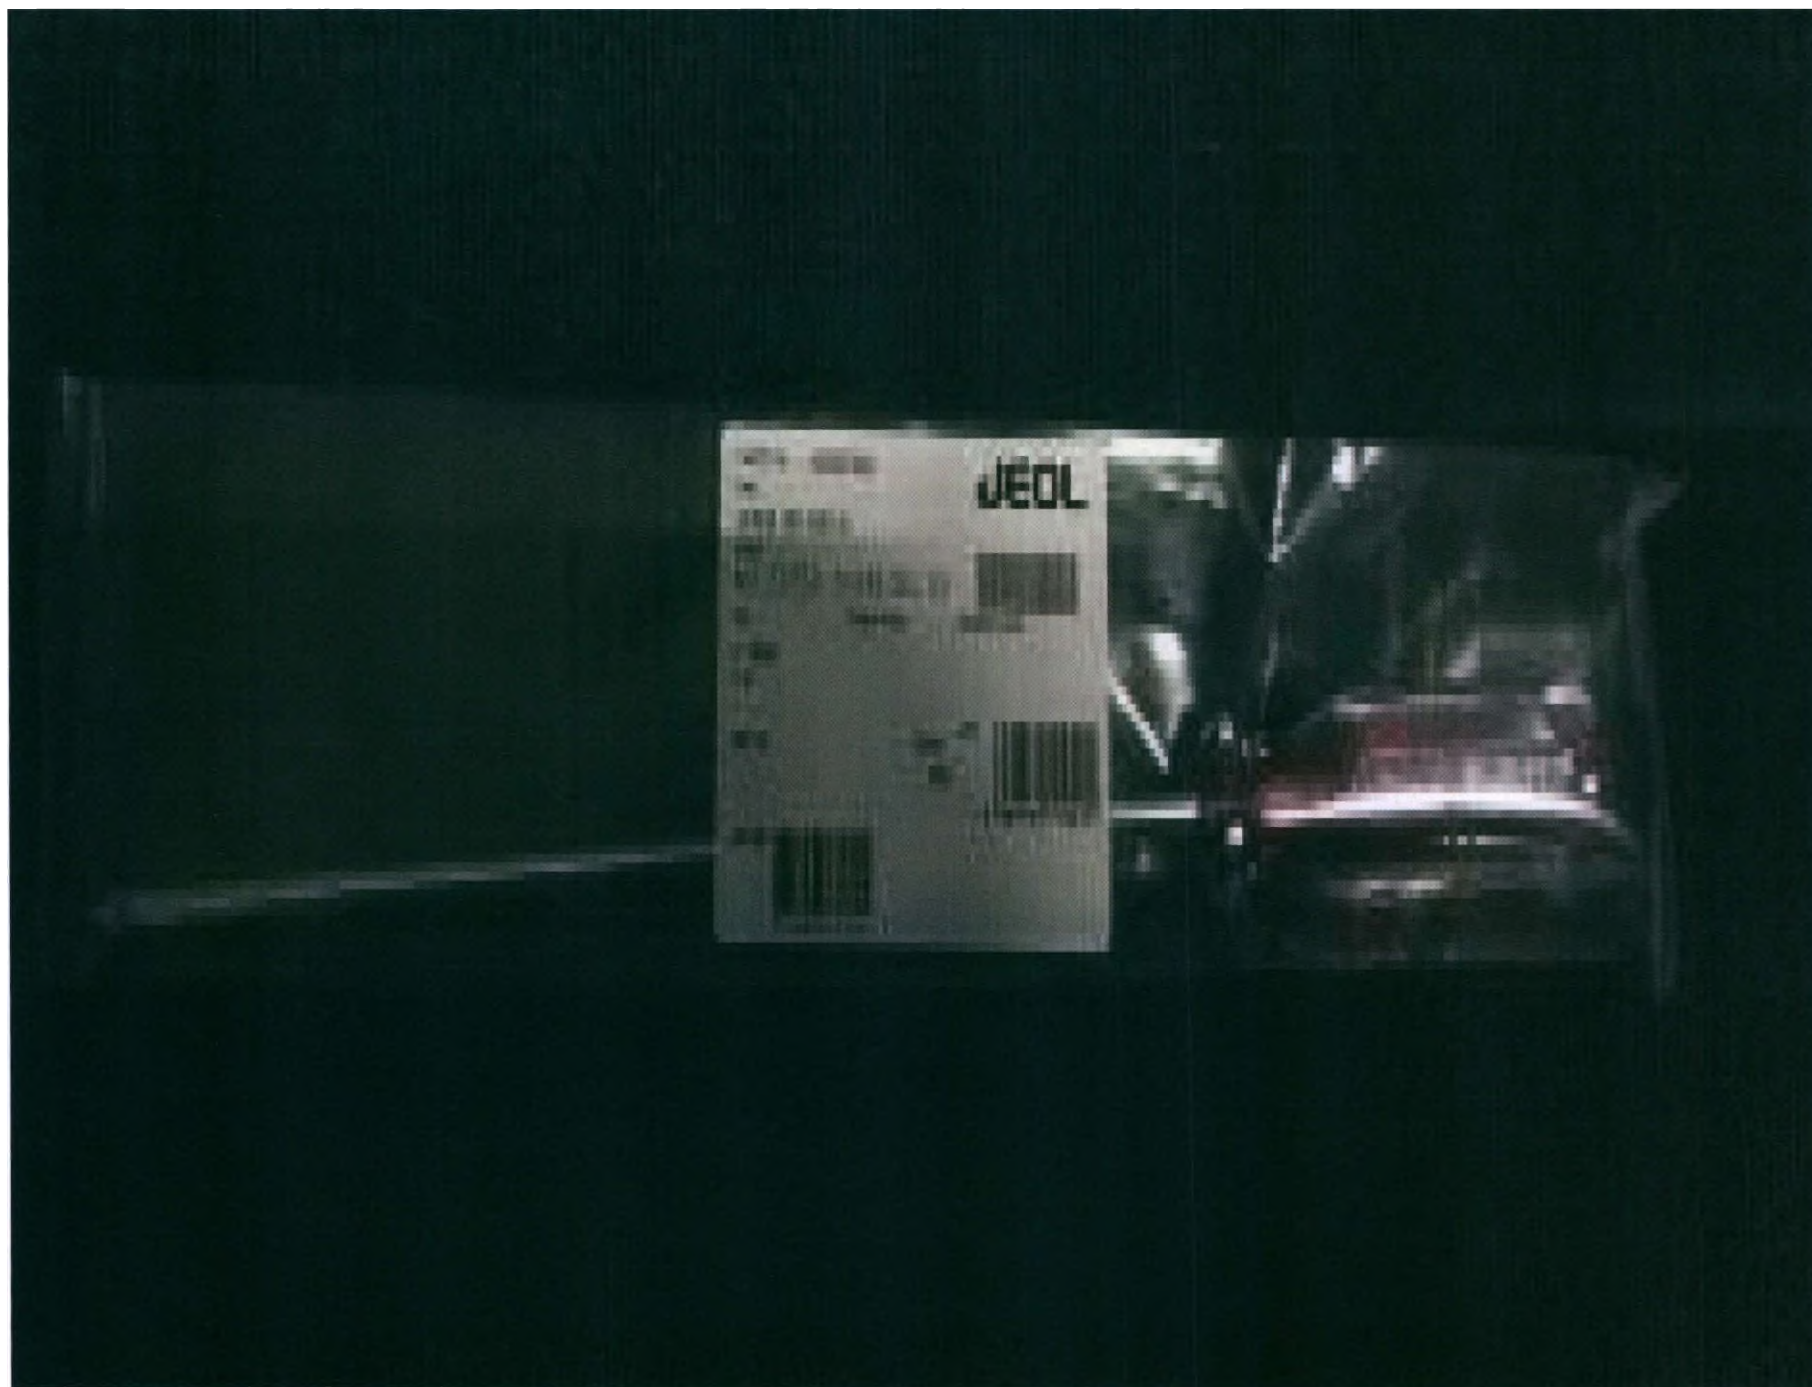


Рисунок 18



Рисунок 19



Рисунок 19

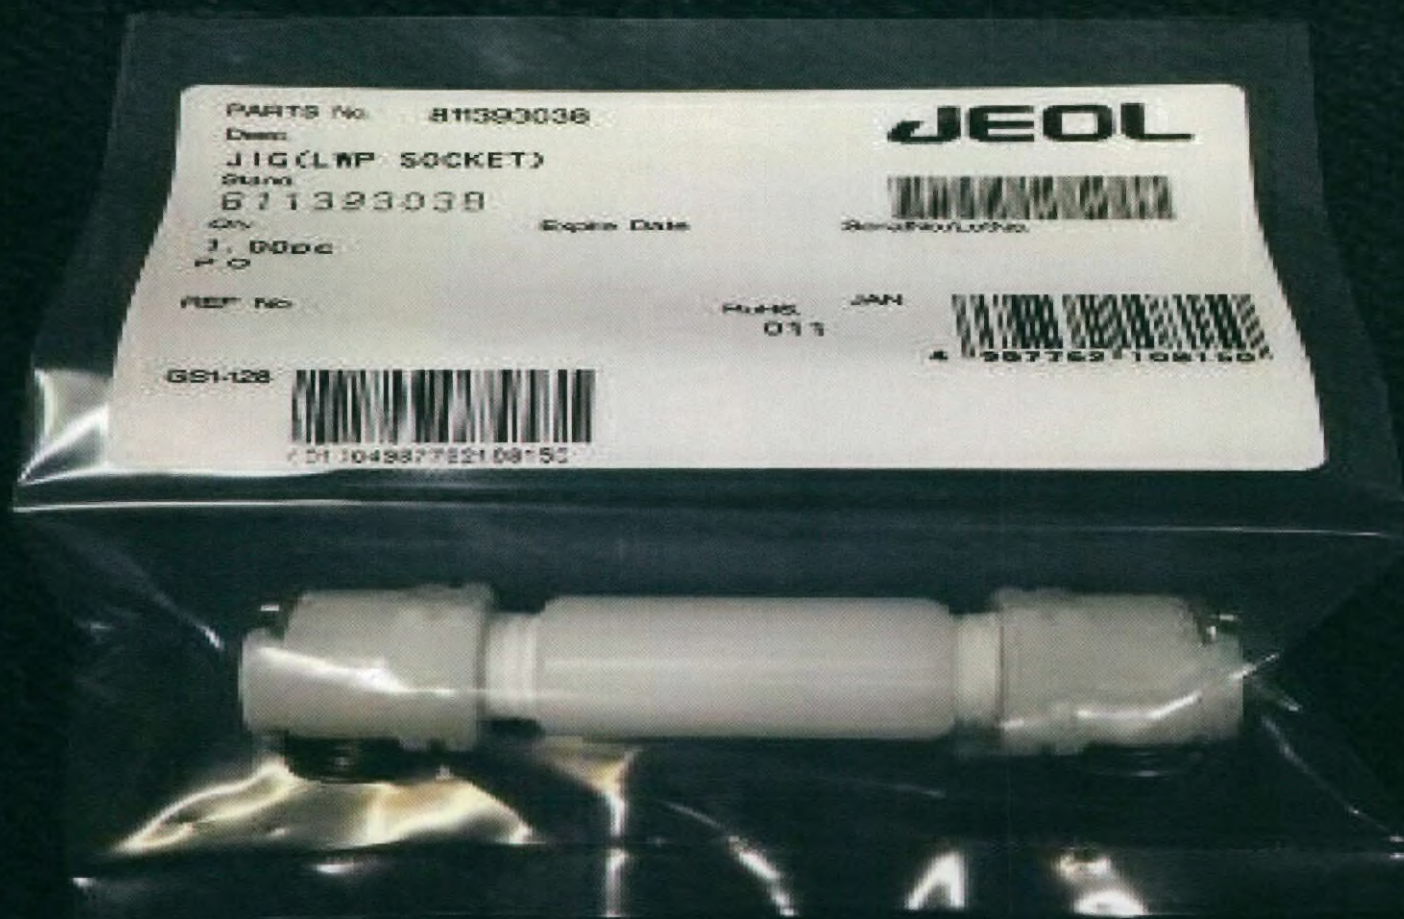


Рисунок 20



Рисунок 11



Рисунок 22



Рисунок 23



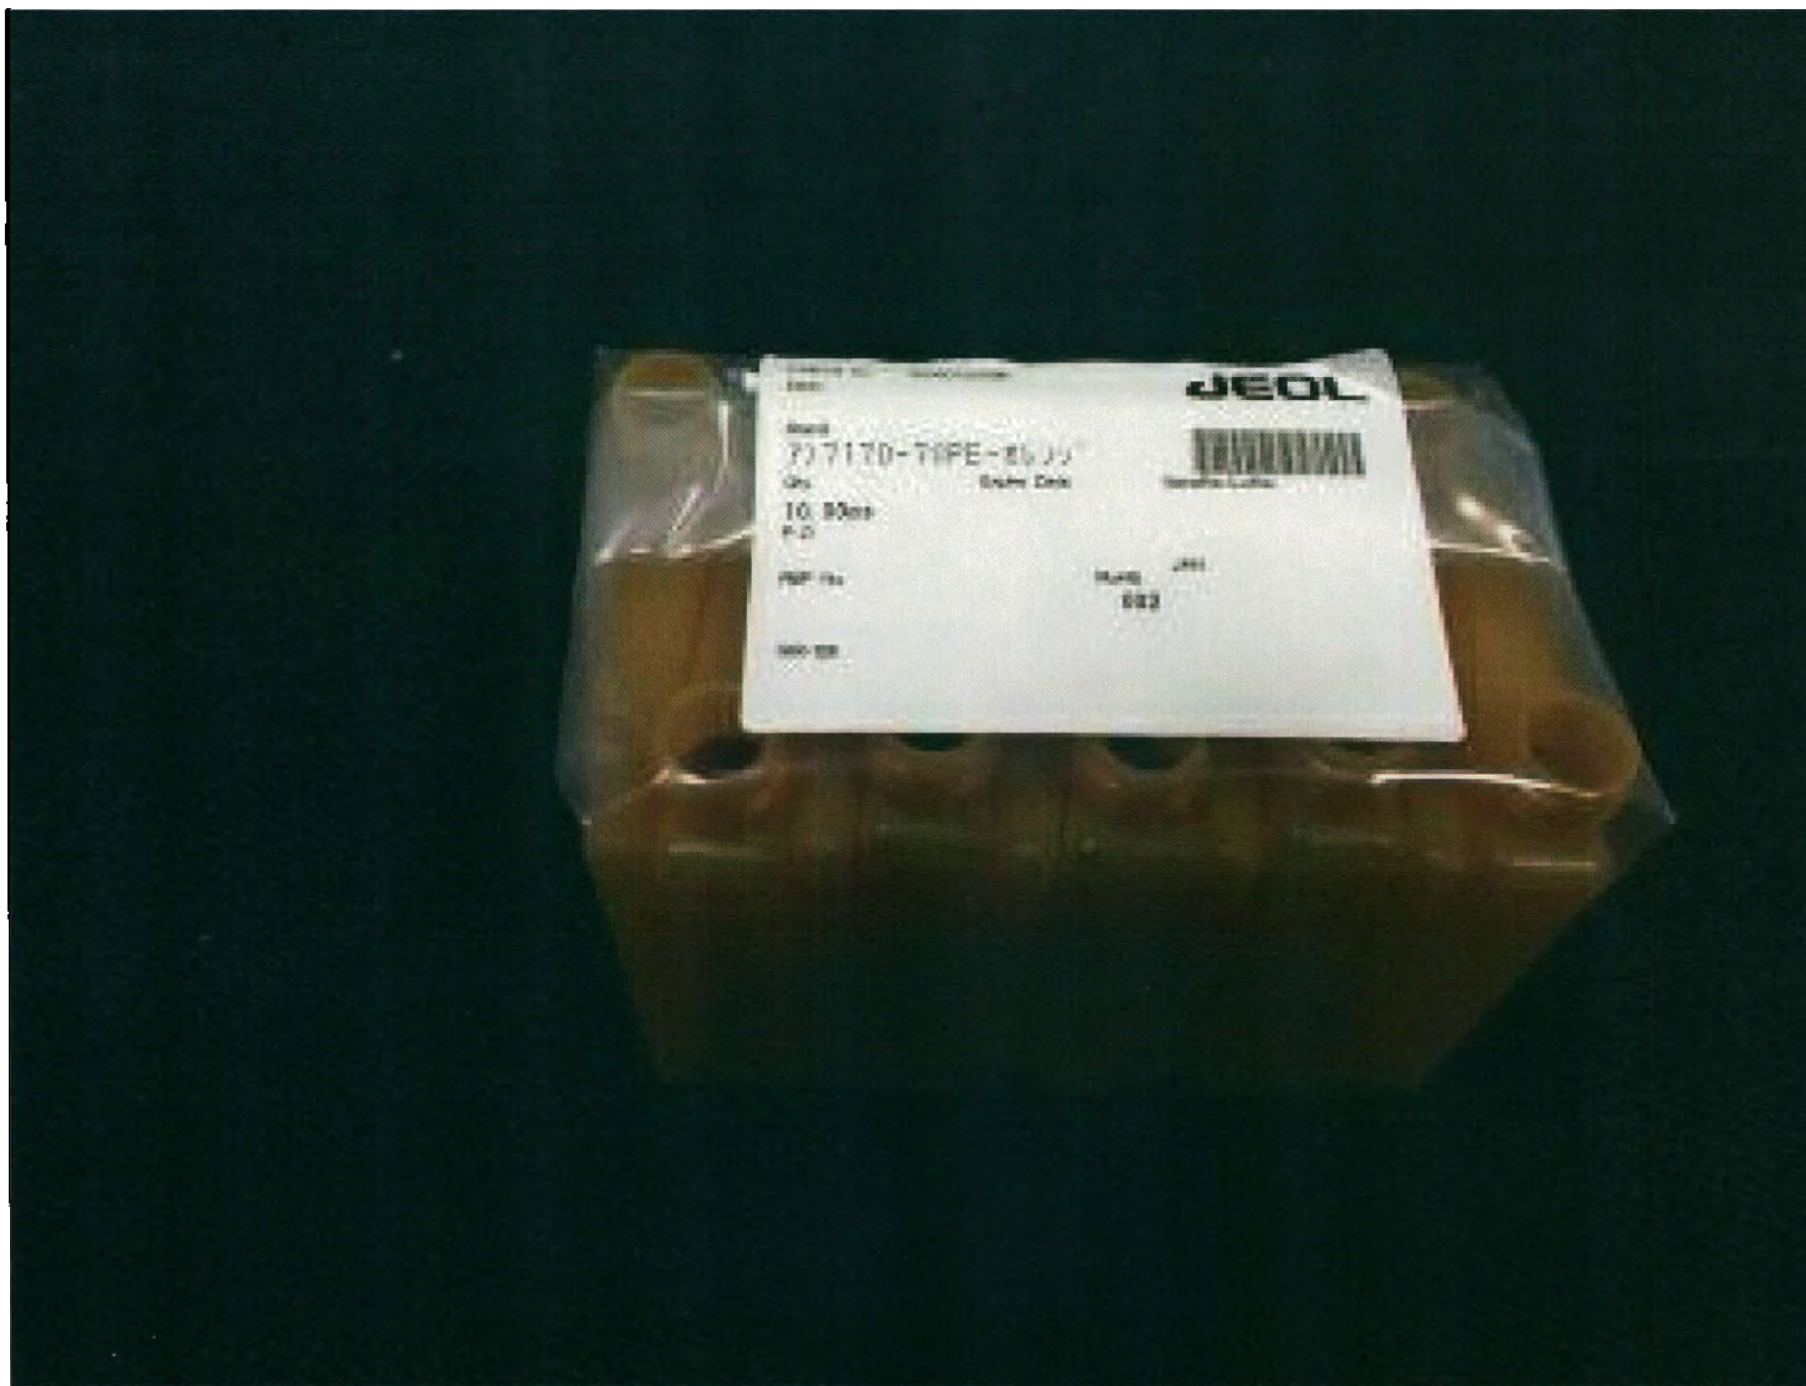


Рисунок 25



Рисунок 26



Рисунок 27



Рисунок 27



Рисунок 28



Рисунок 29



Рисунок 30



Рисунок 31



Рисунок 32

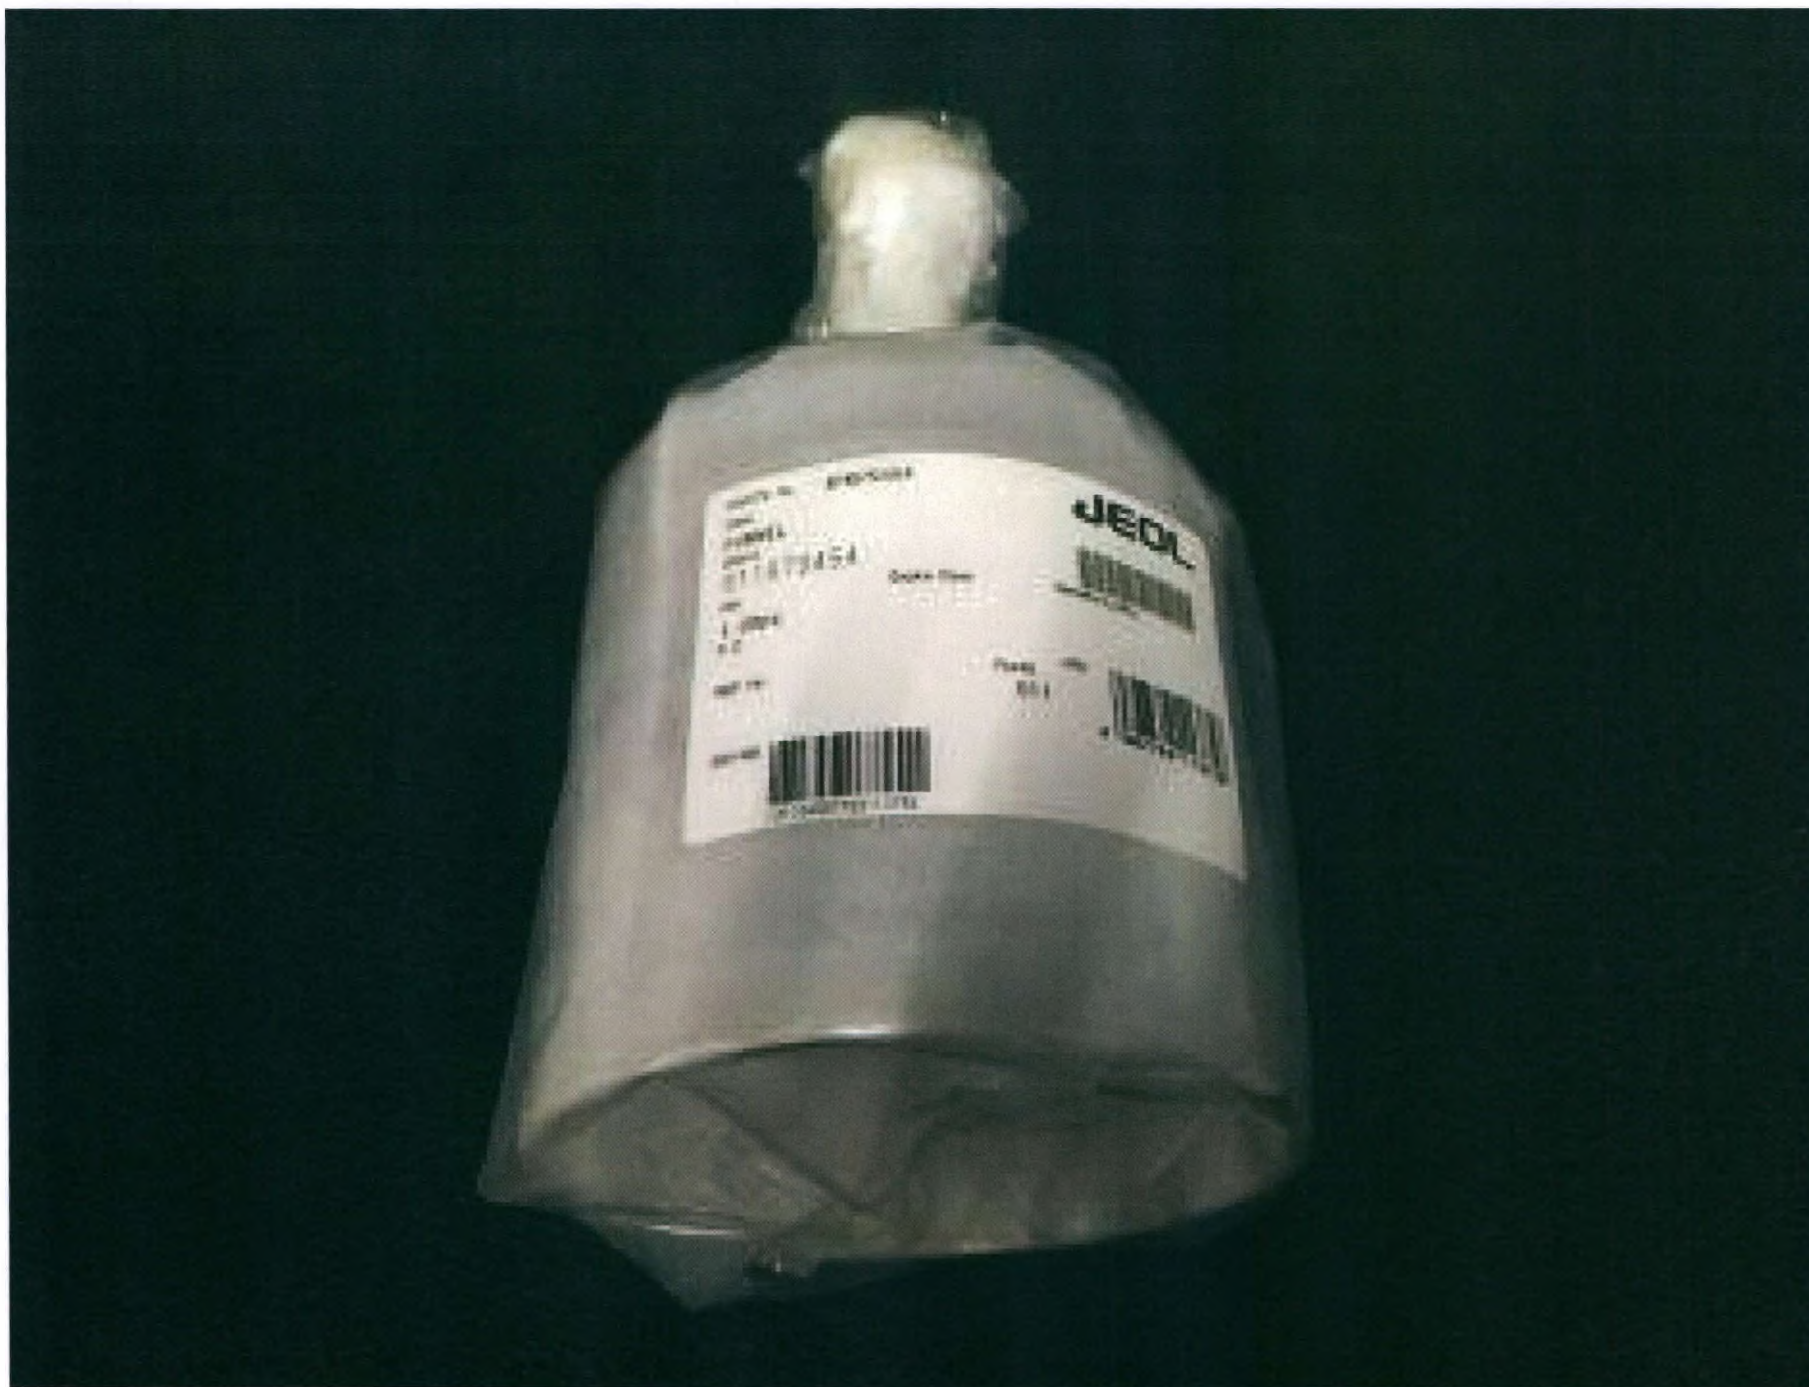


Рисунок 33



Рисунок 34



Рисунок 35



Рисунок 36



Рисунок 37



Рисунок 38



Рисунок 39



Рисунок 40



Рисунок 41



Рисунок 42



Рисунок 43



Рисунок 44

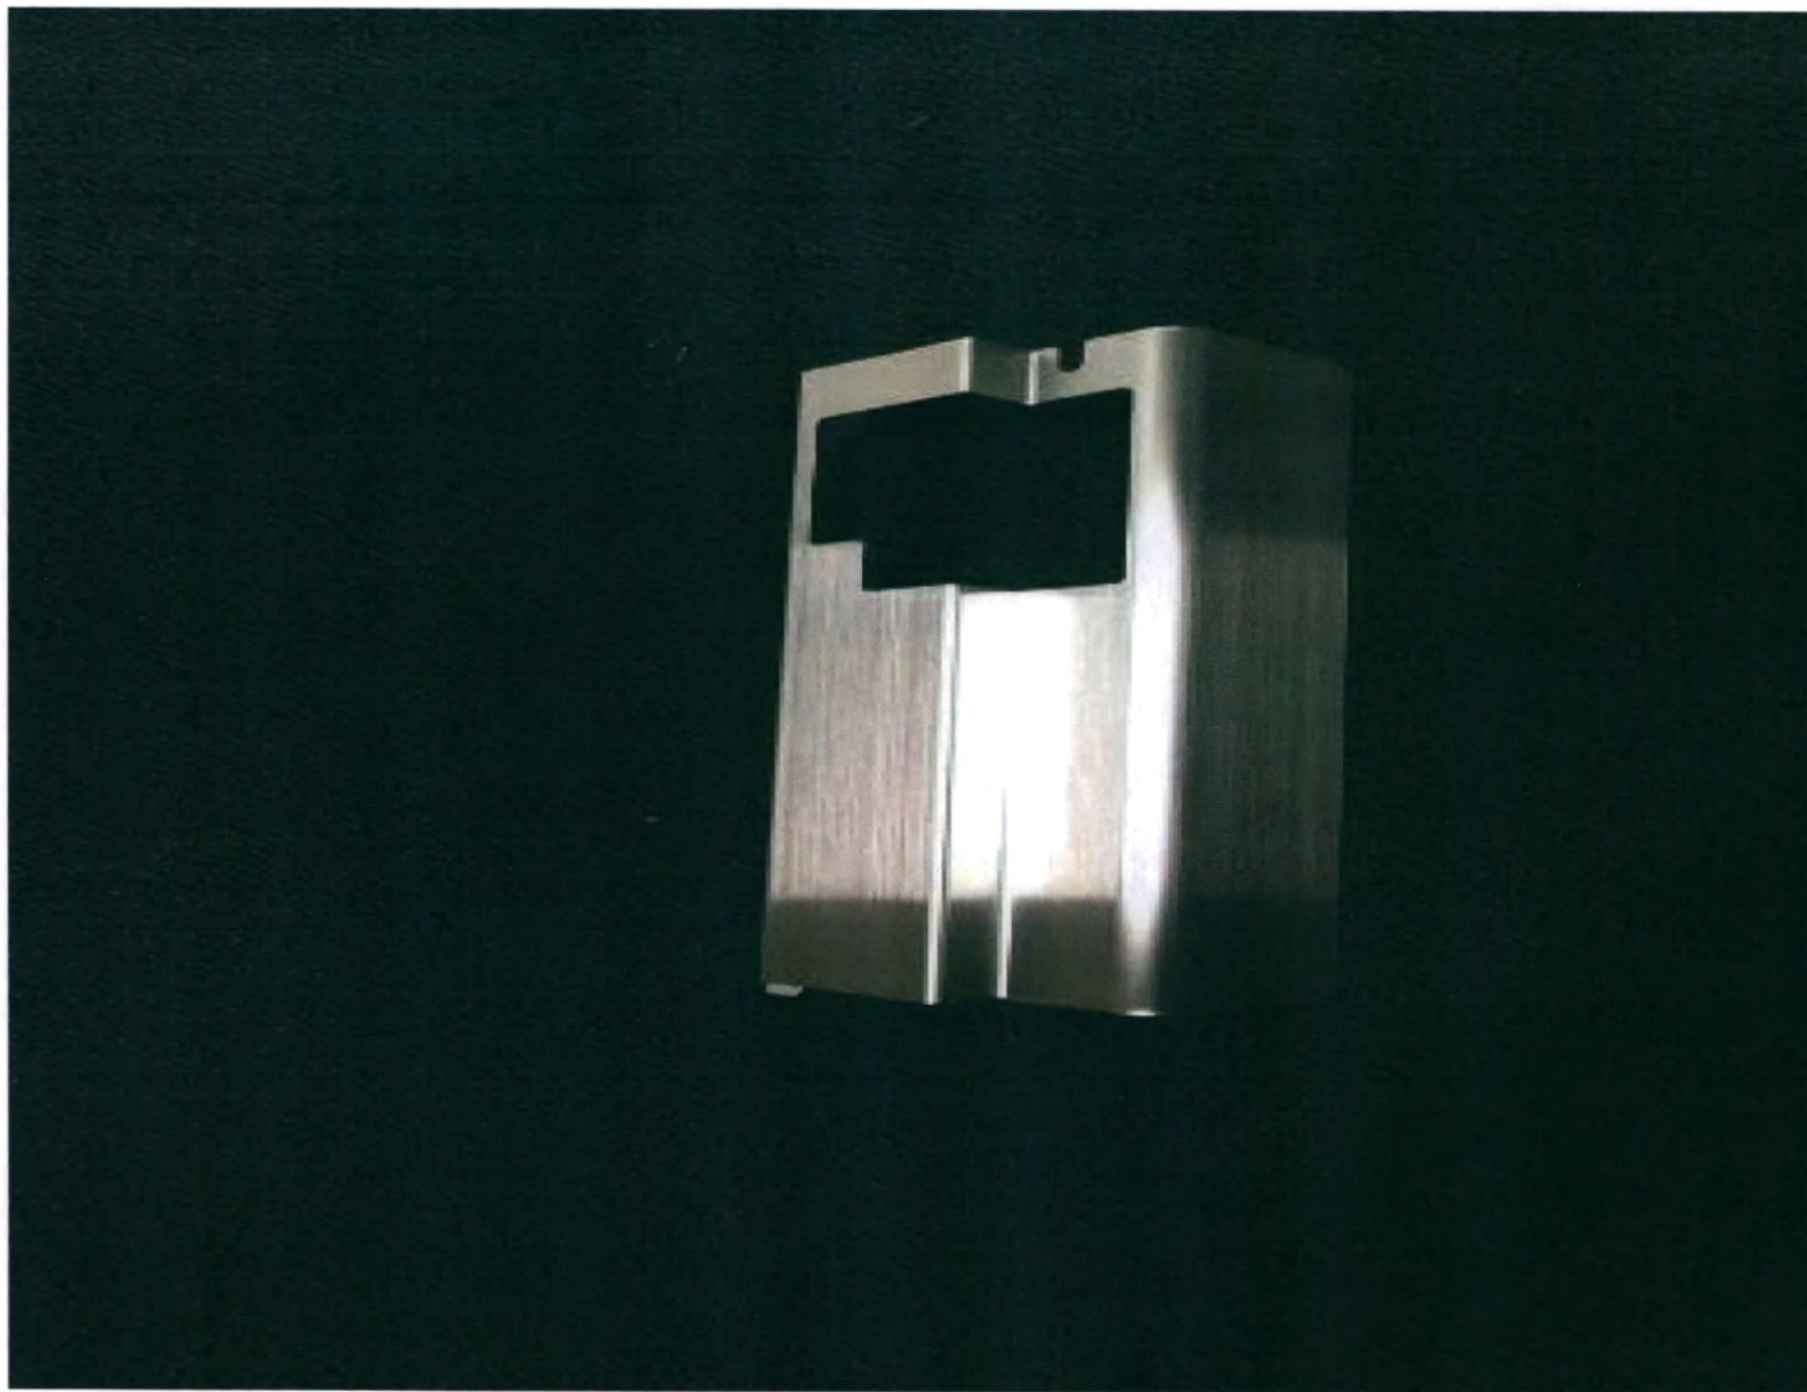


Рисунок 45



Рисунок 46



Рисунок 46

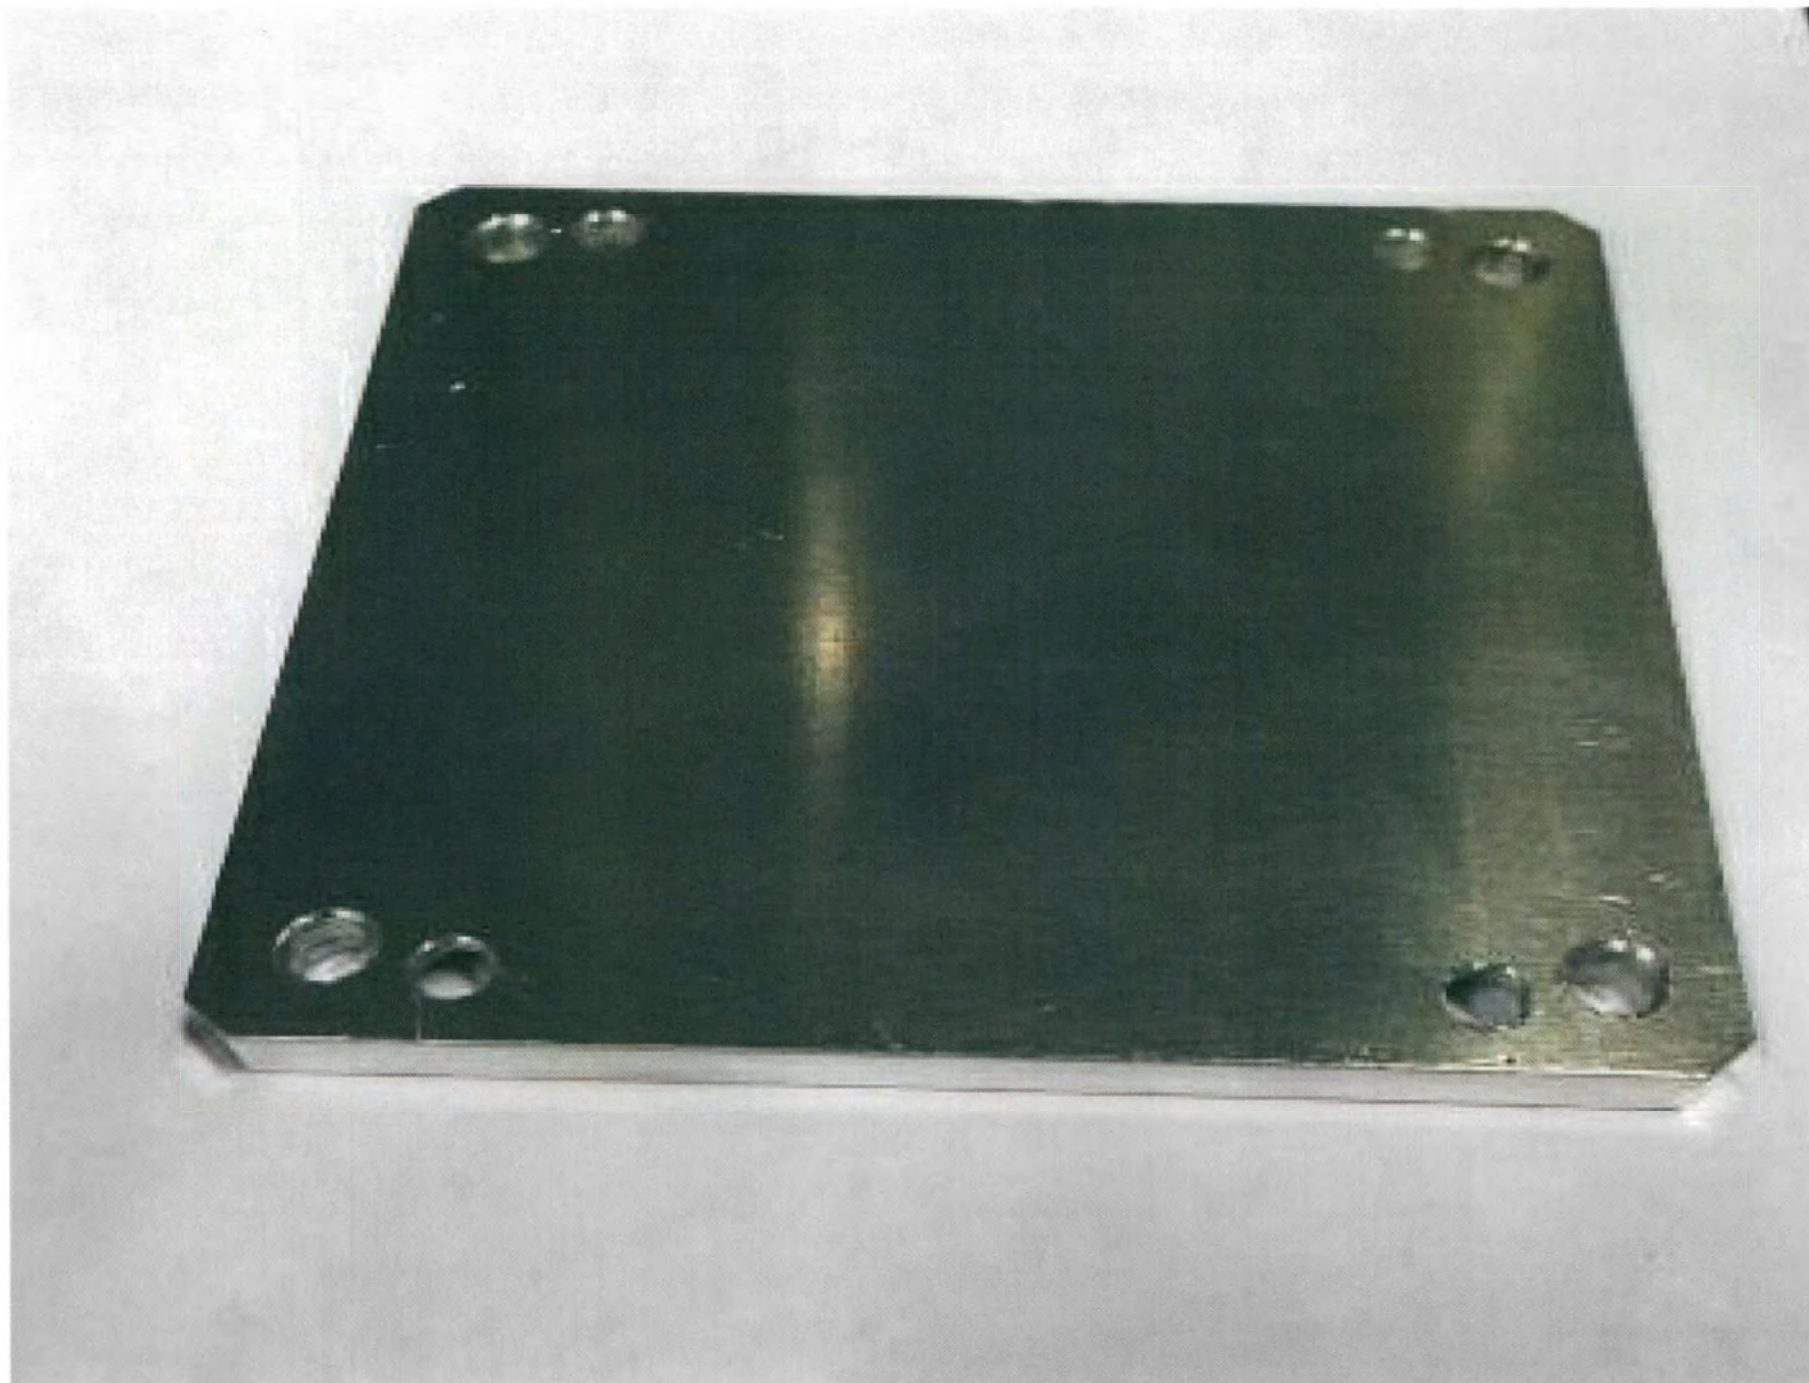


Рисунок 47



Рисунок 48



Рисунок 49



Рисунок 50



Рисунок 51



Рисунок 52

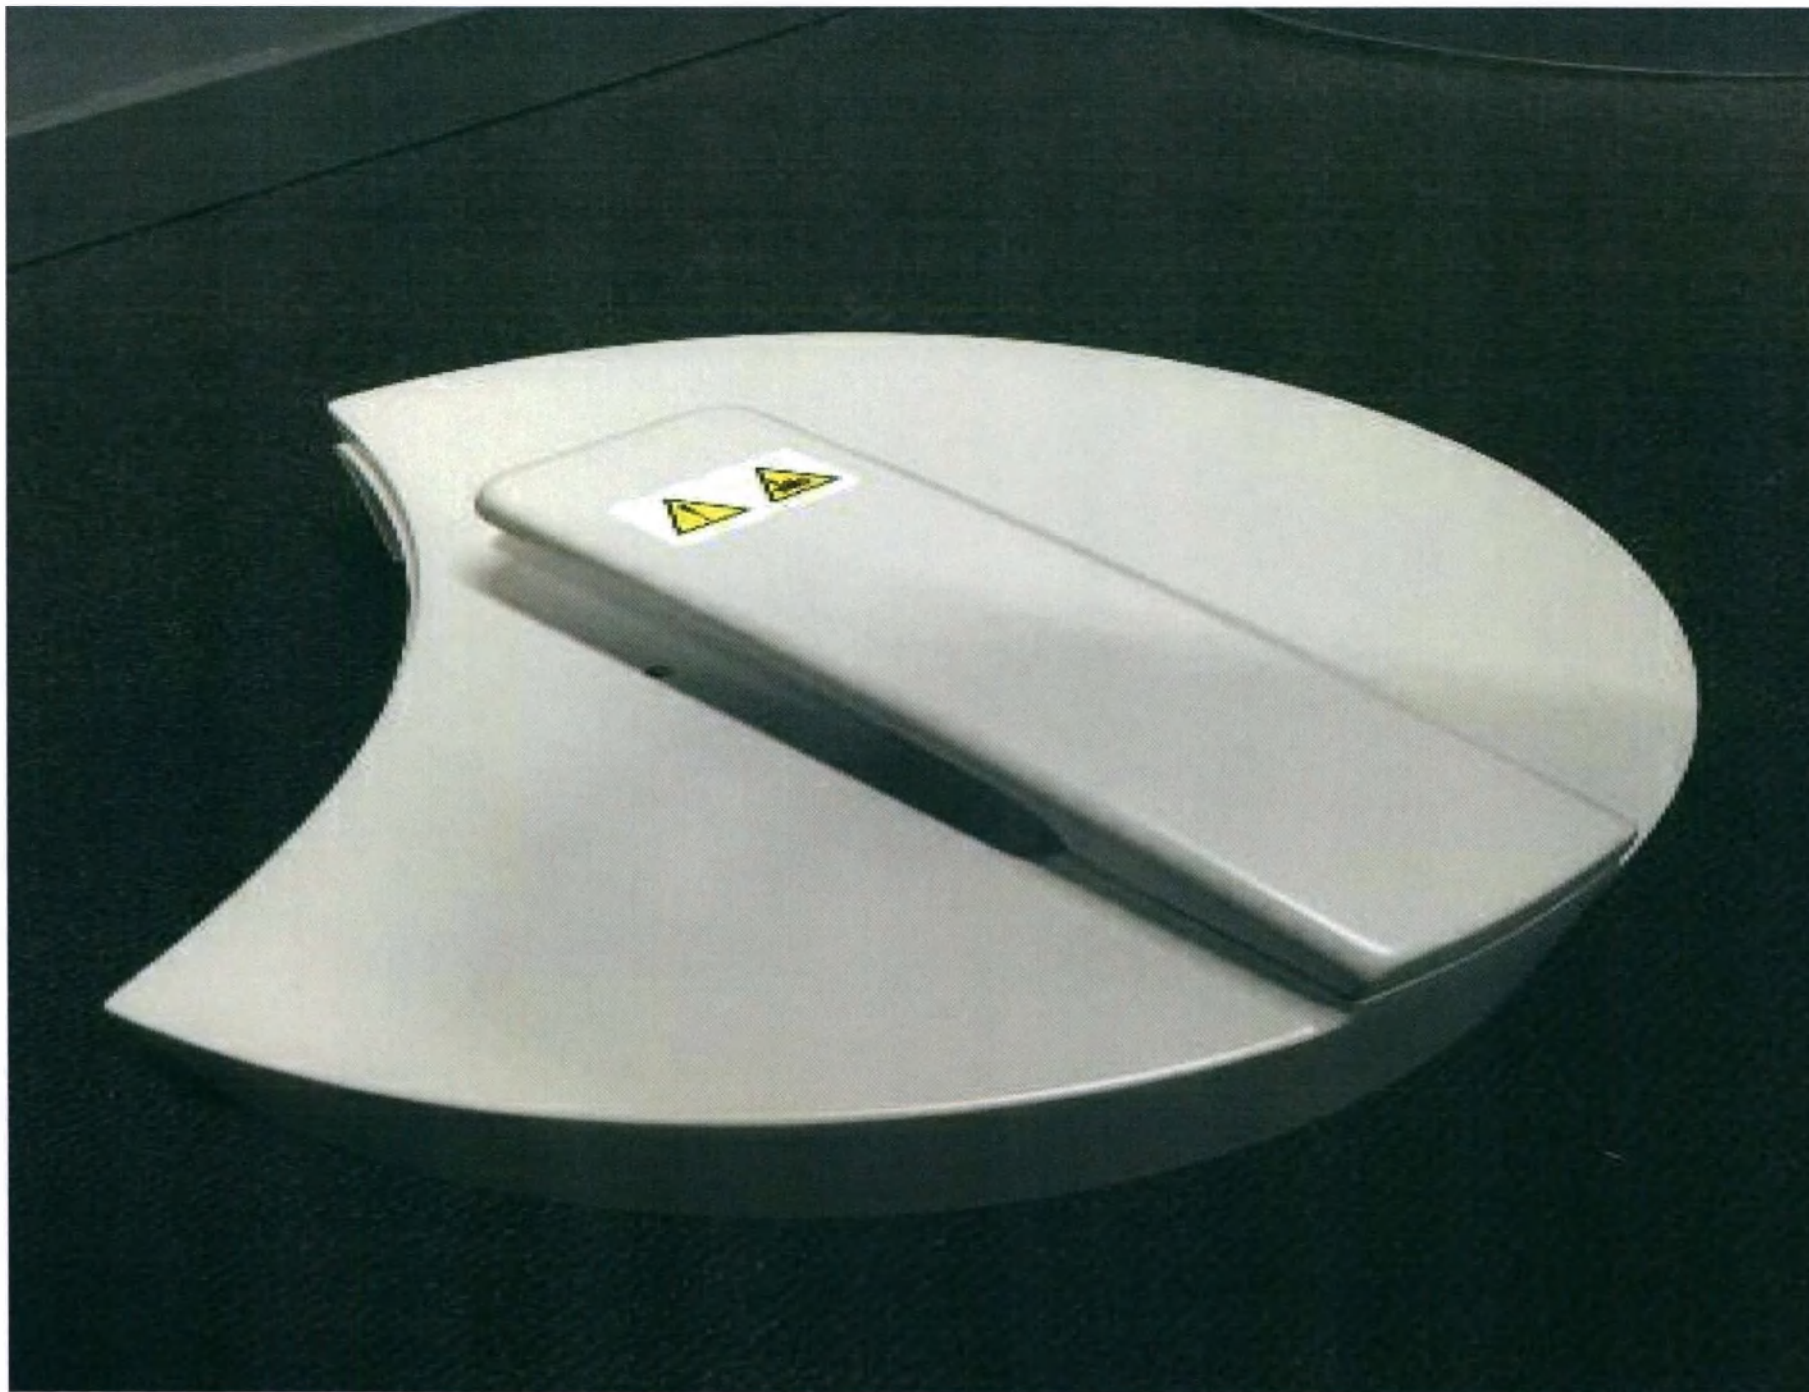


Рисунок 53

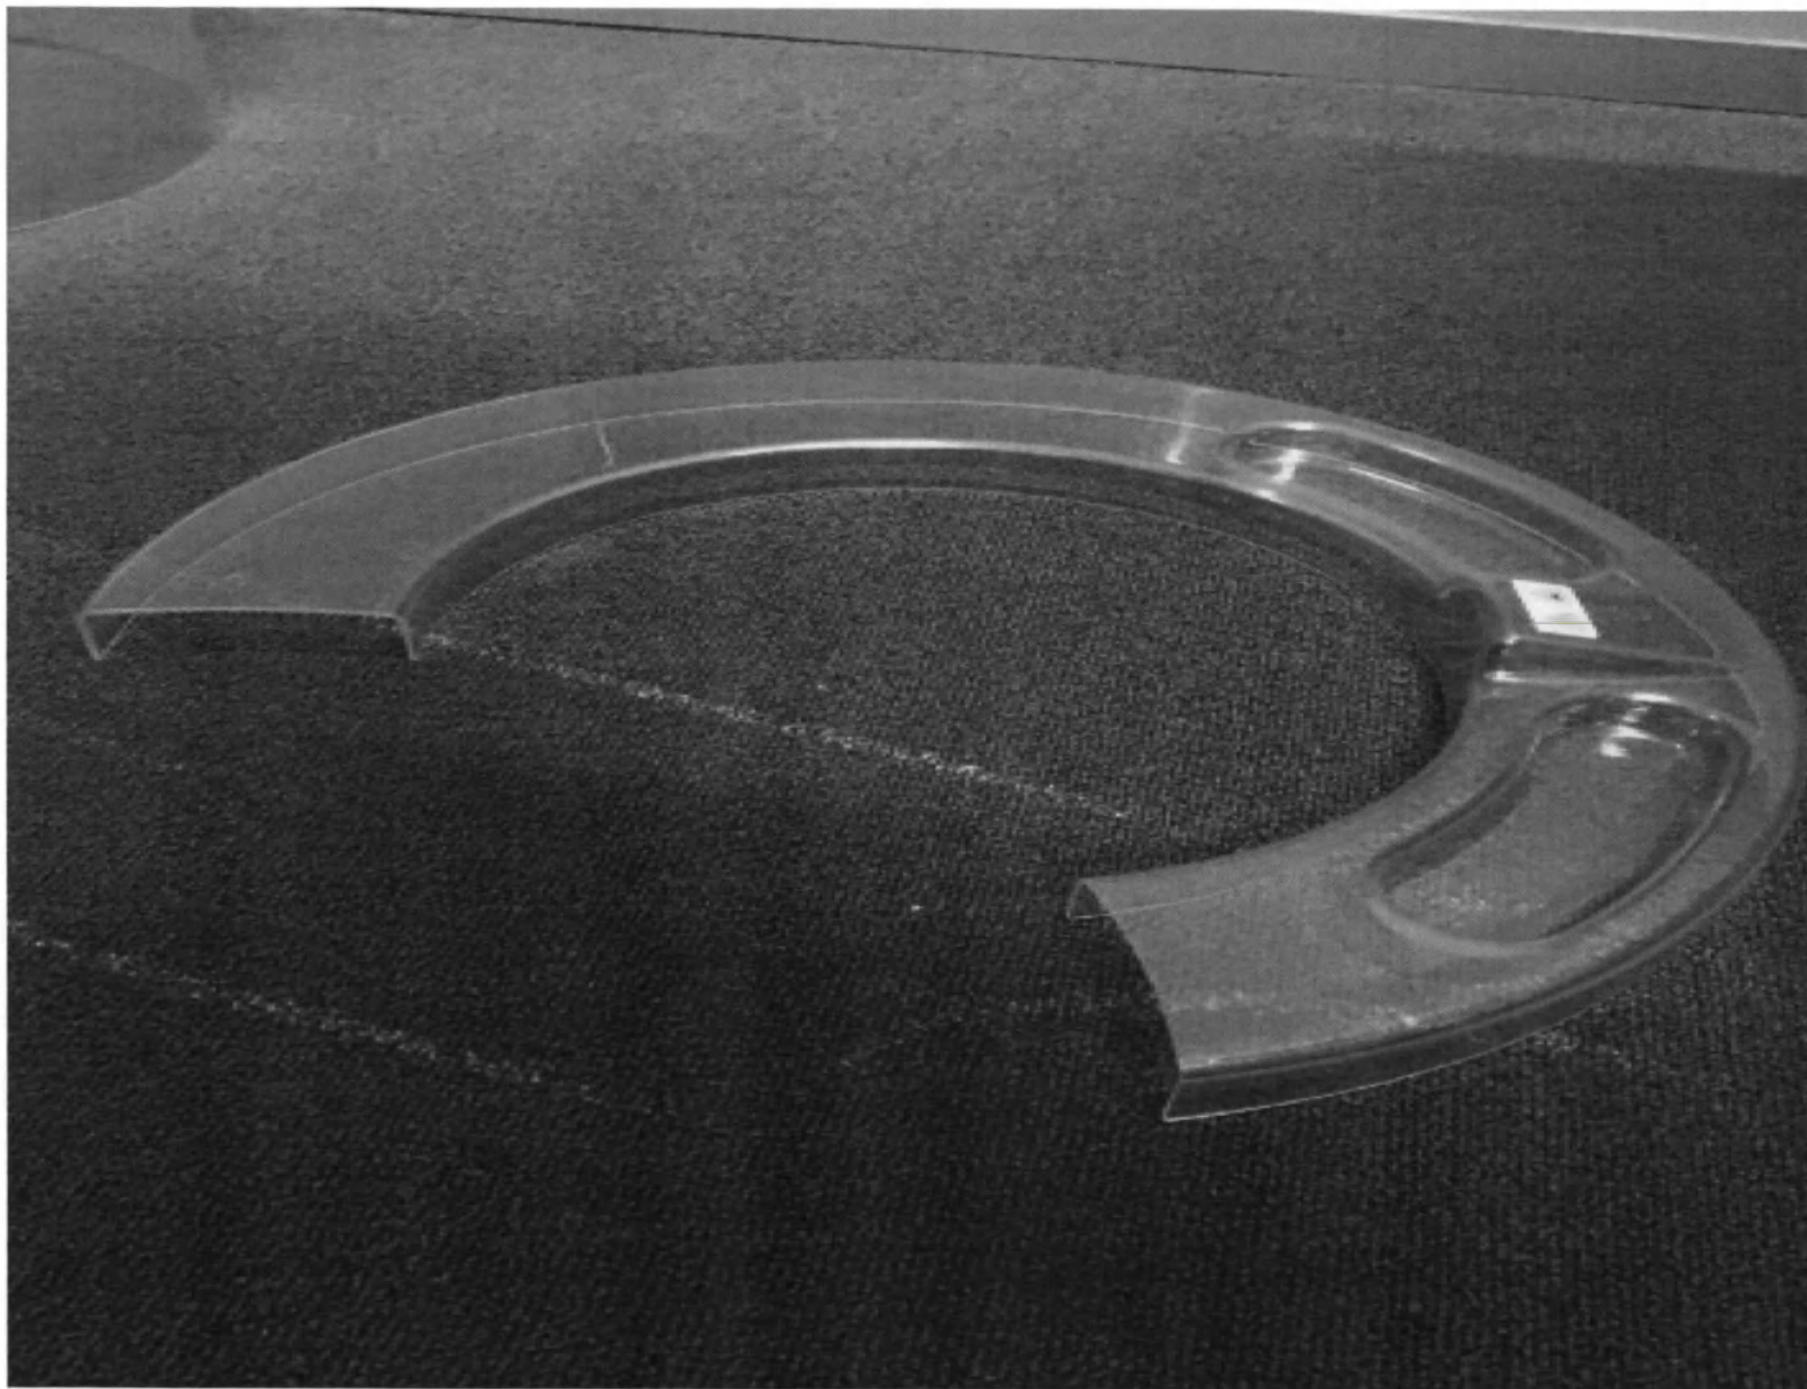


Рисунок 54

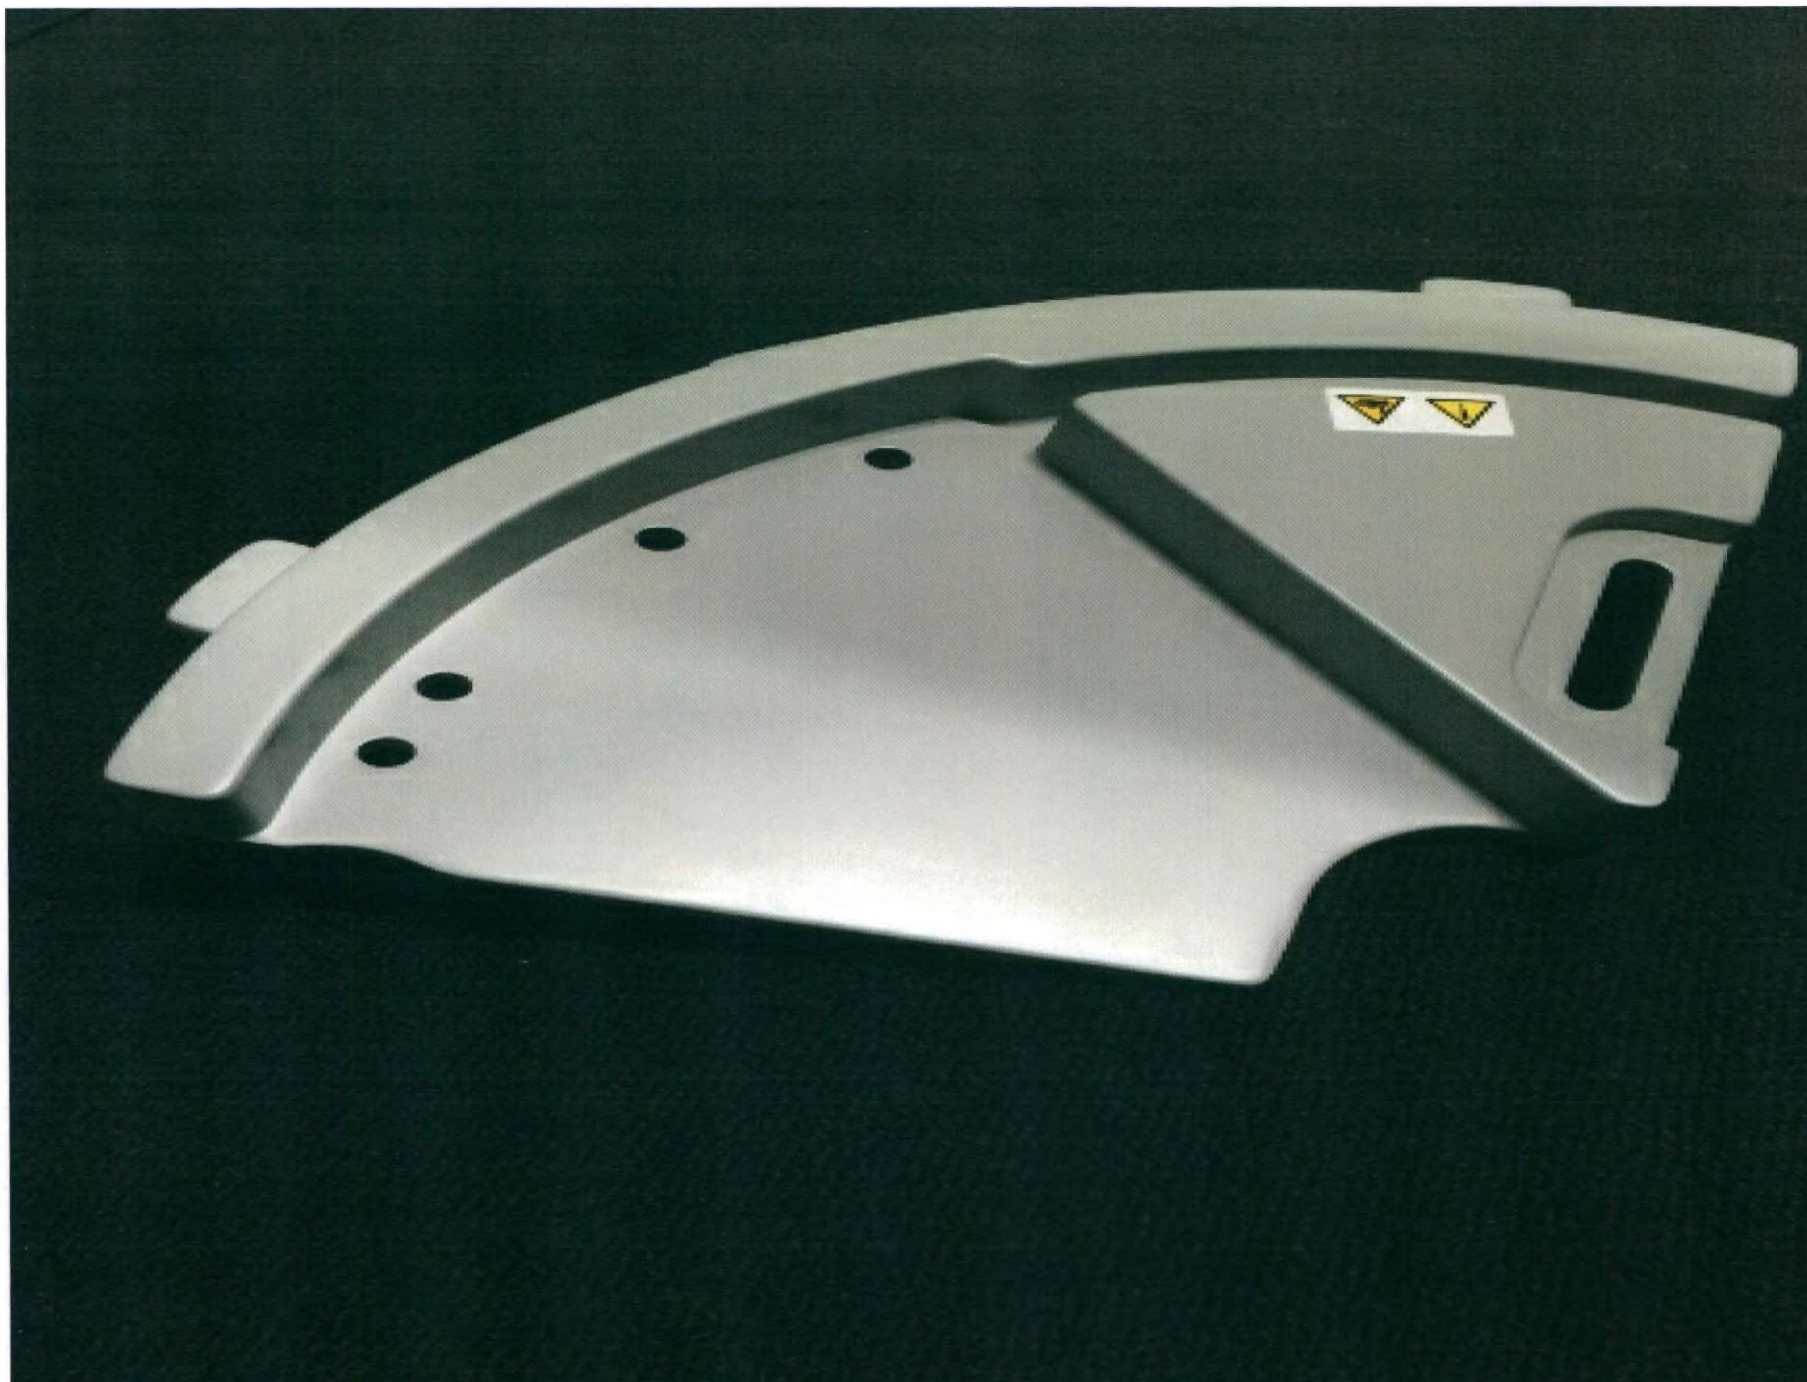


Рисунок 55



Рисунок 56

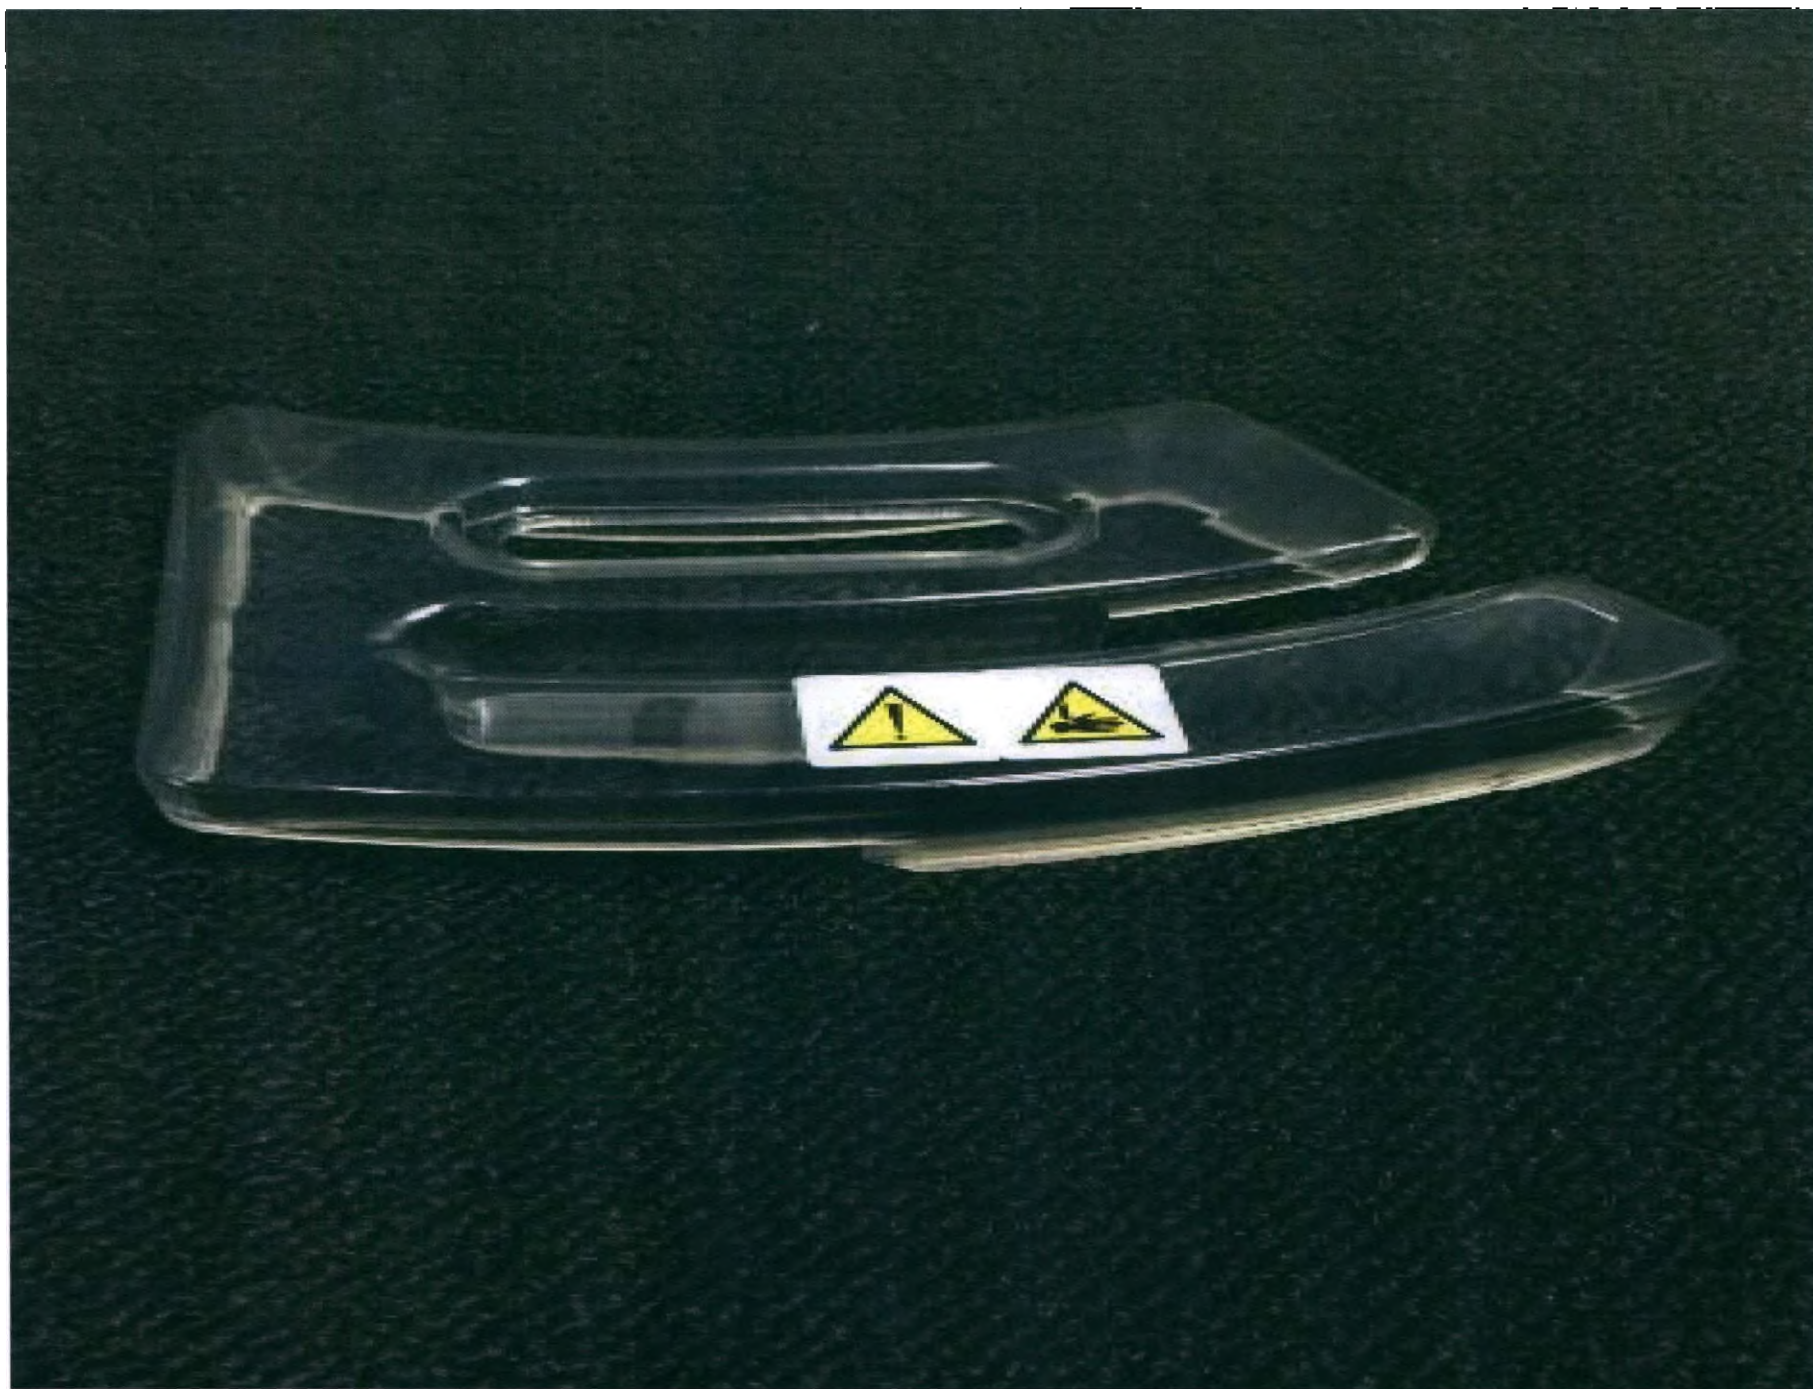


Рисунок 57



Рисунок 58

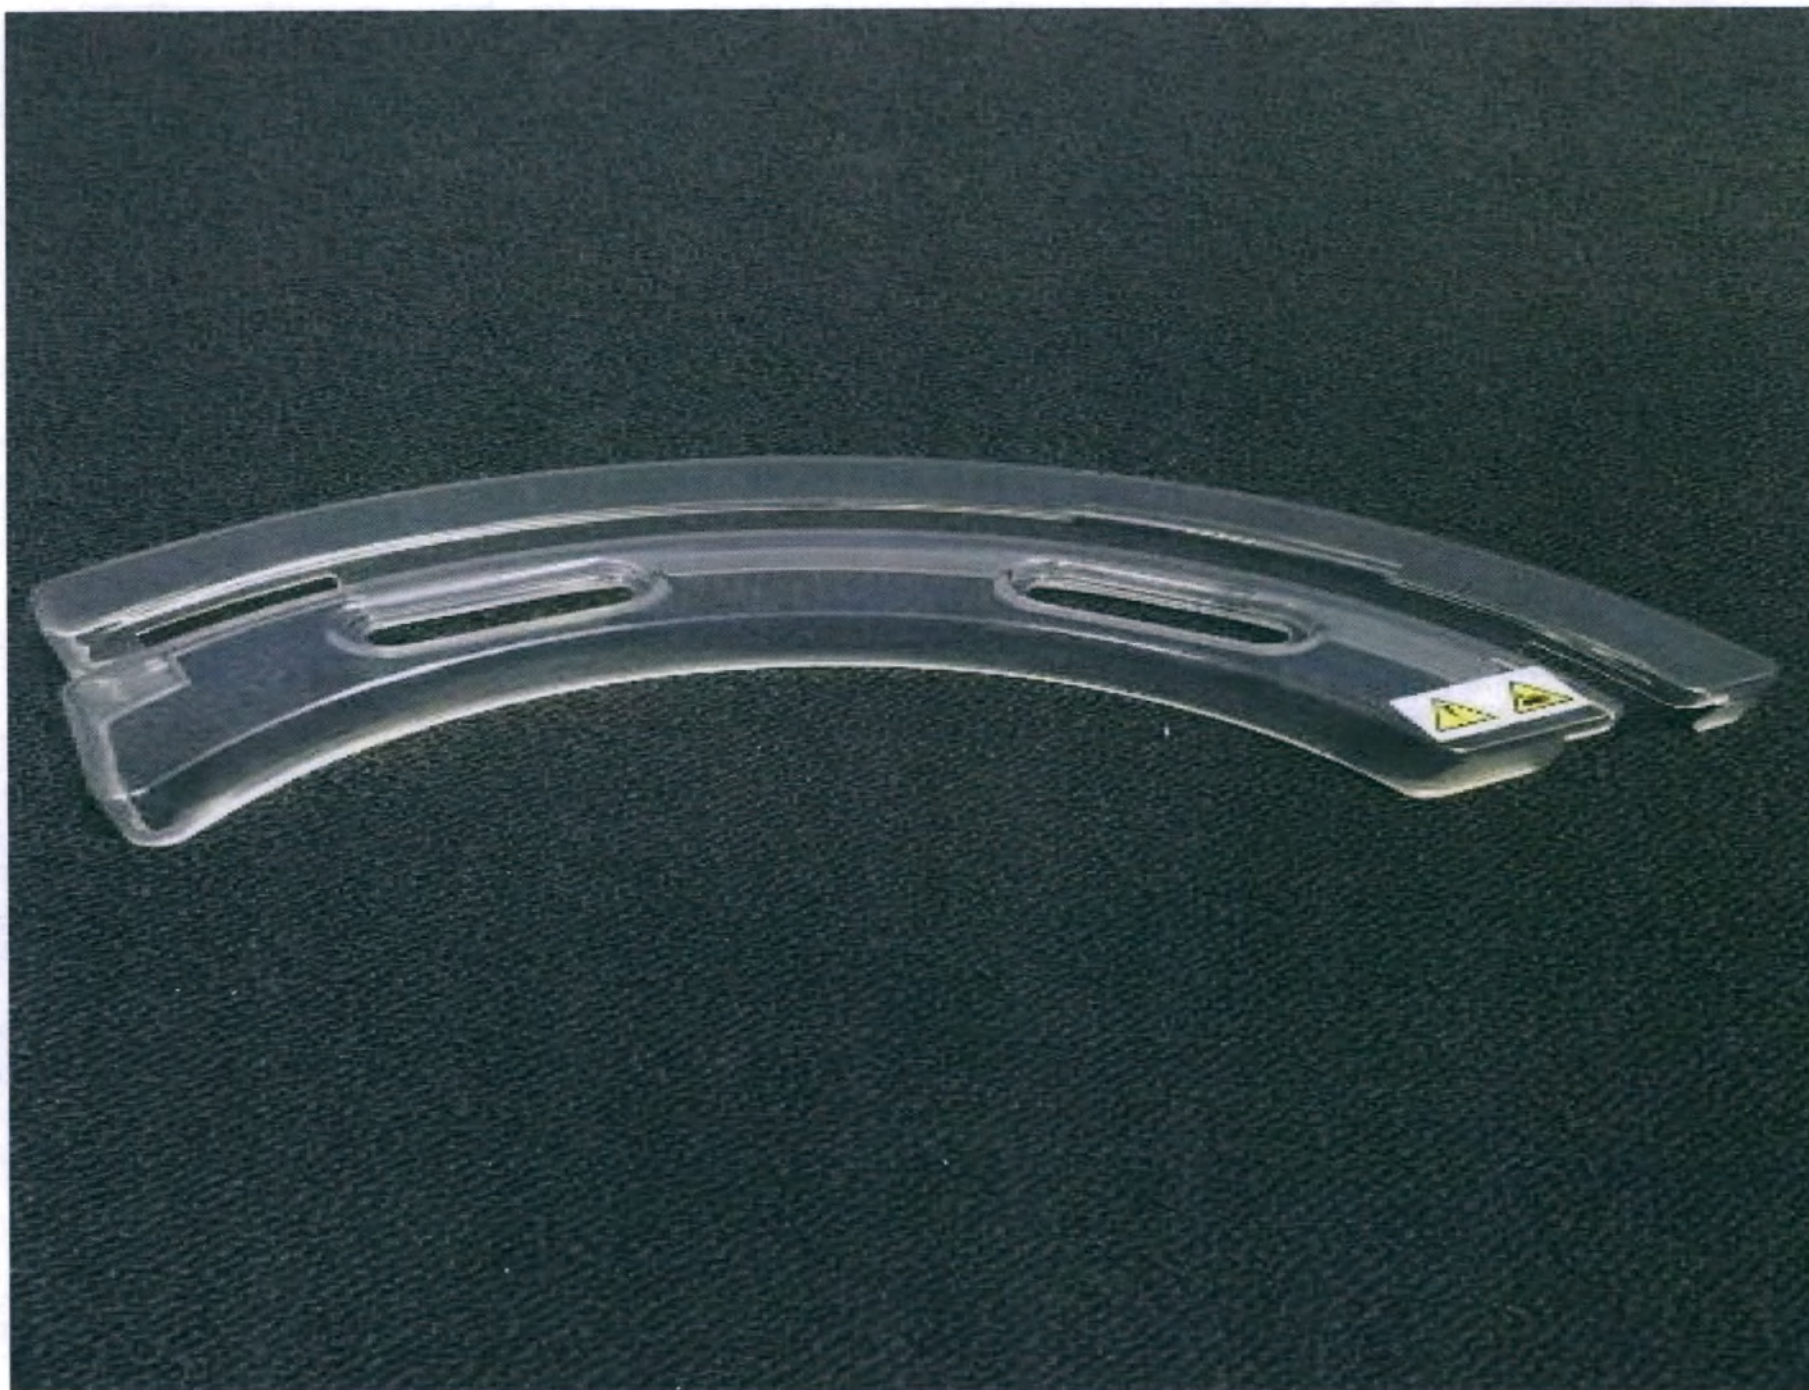


Рисунок 59



Рисунок 60



Рисунок 61

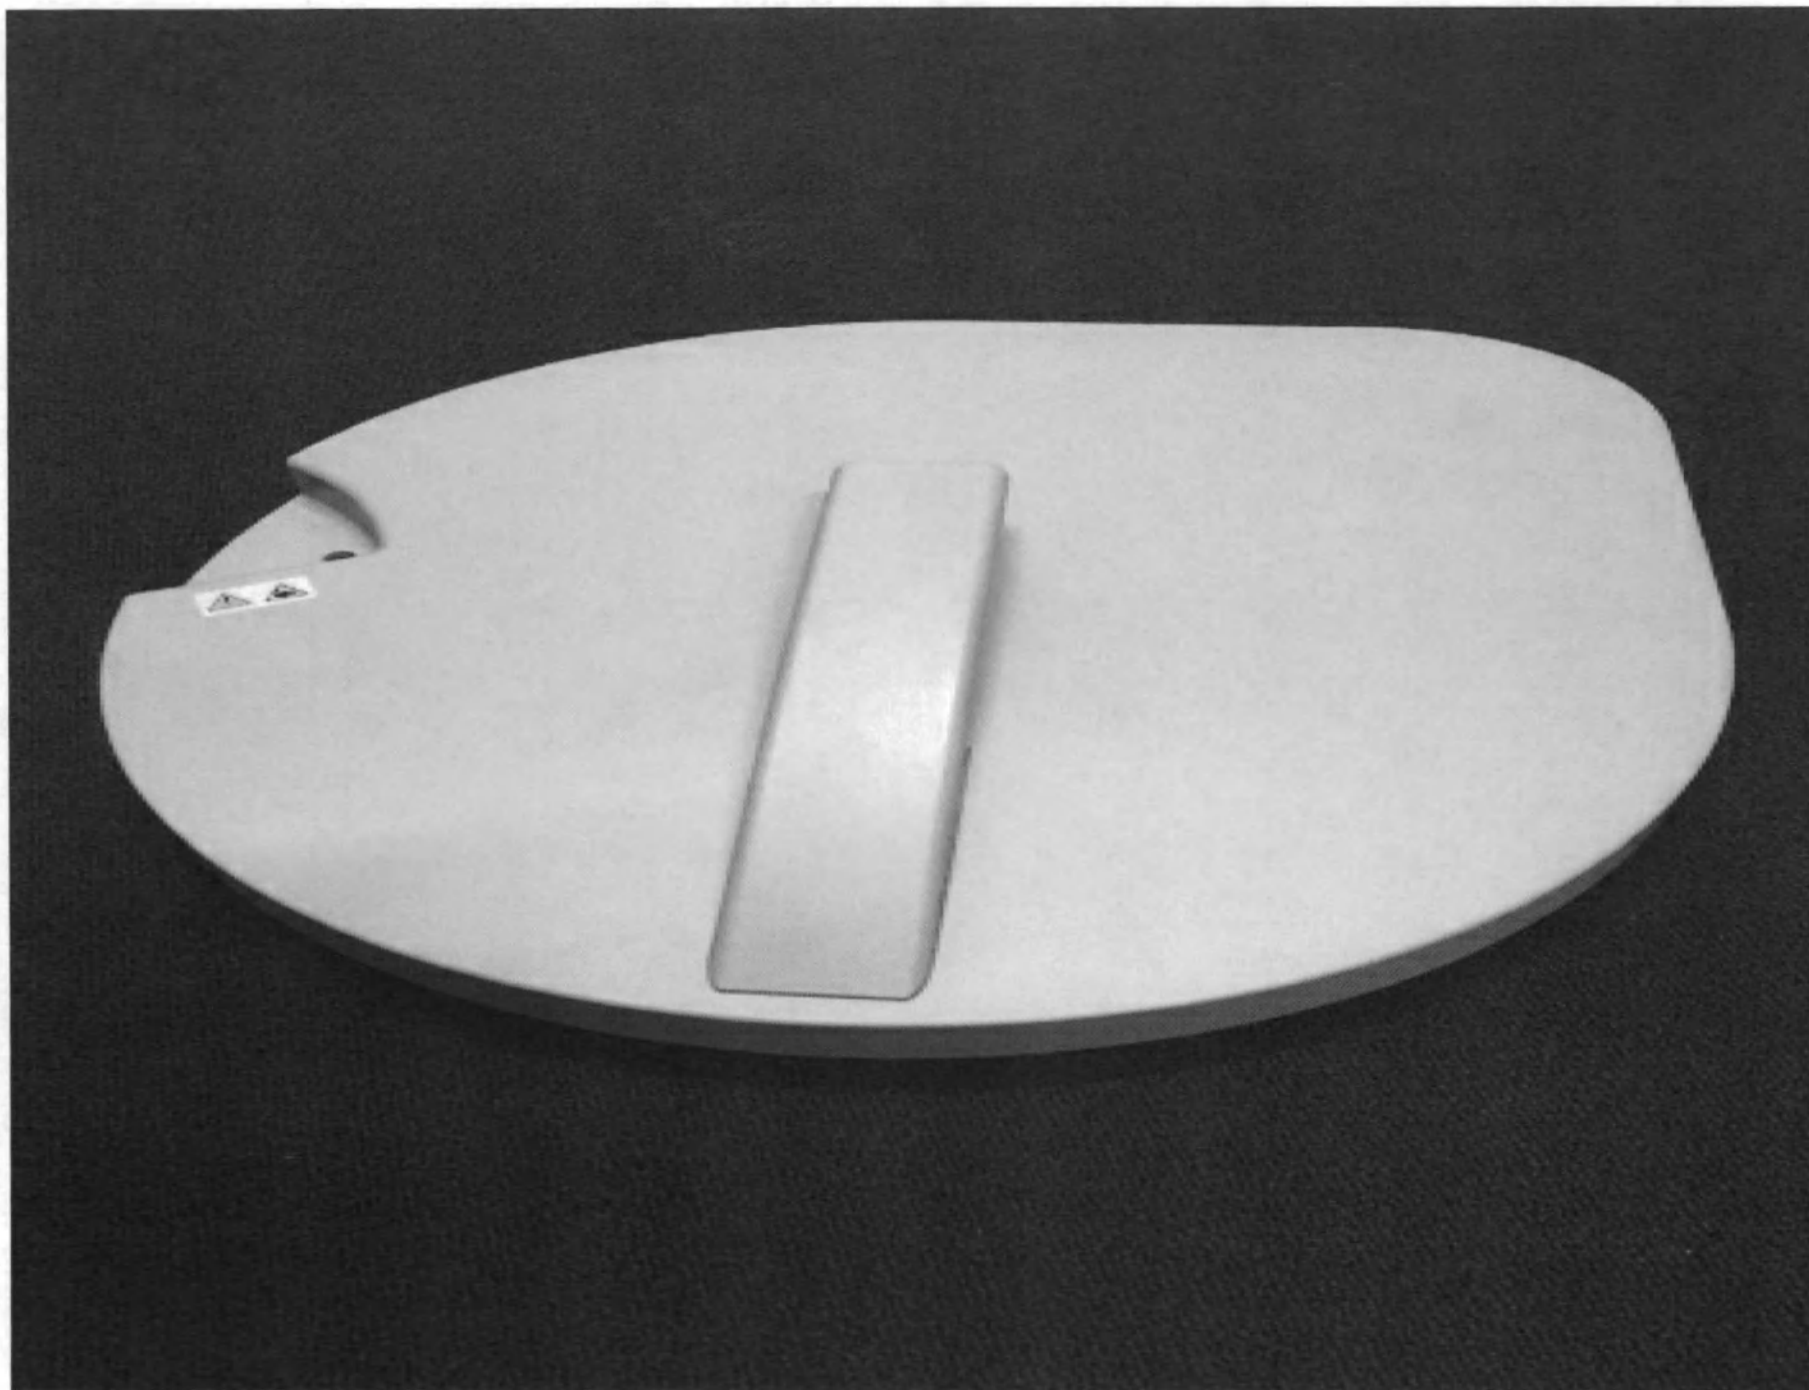


Рисунок 62

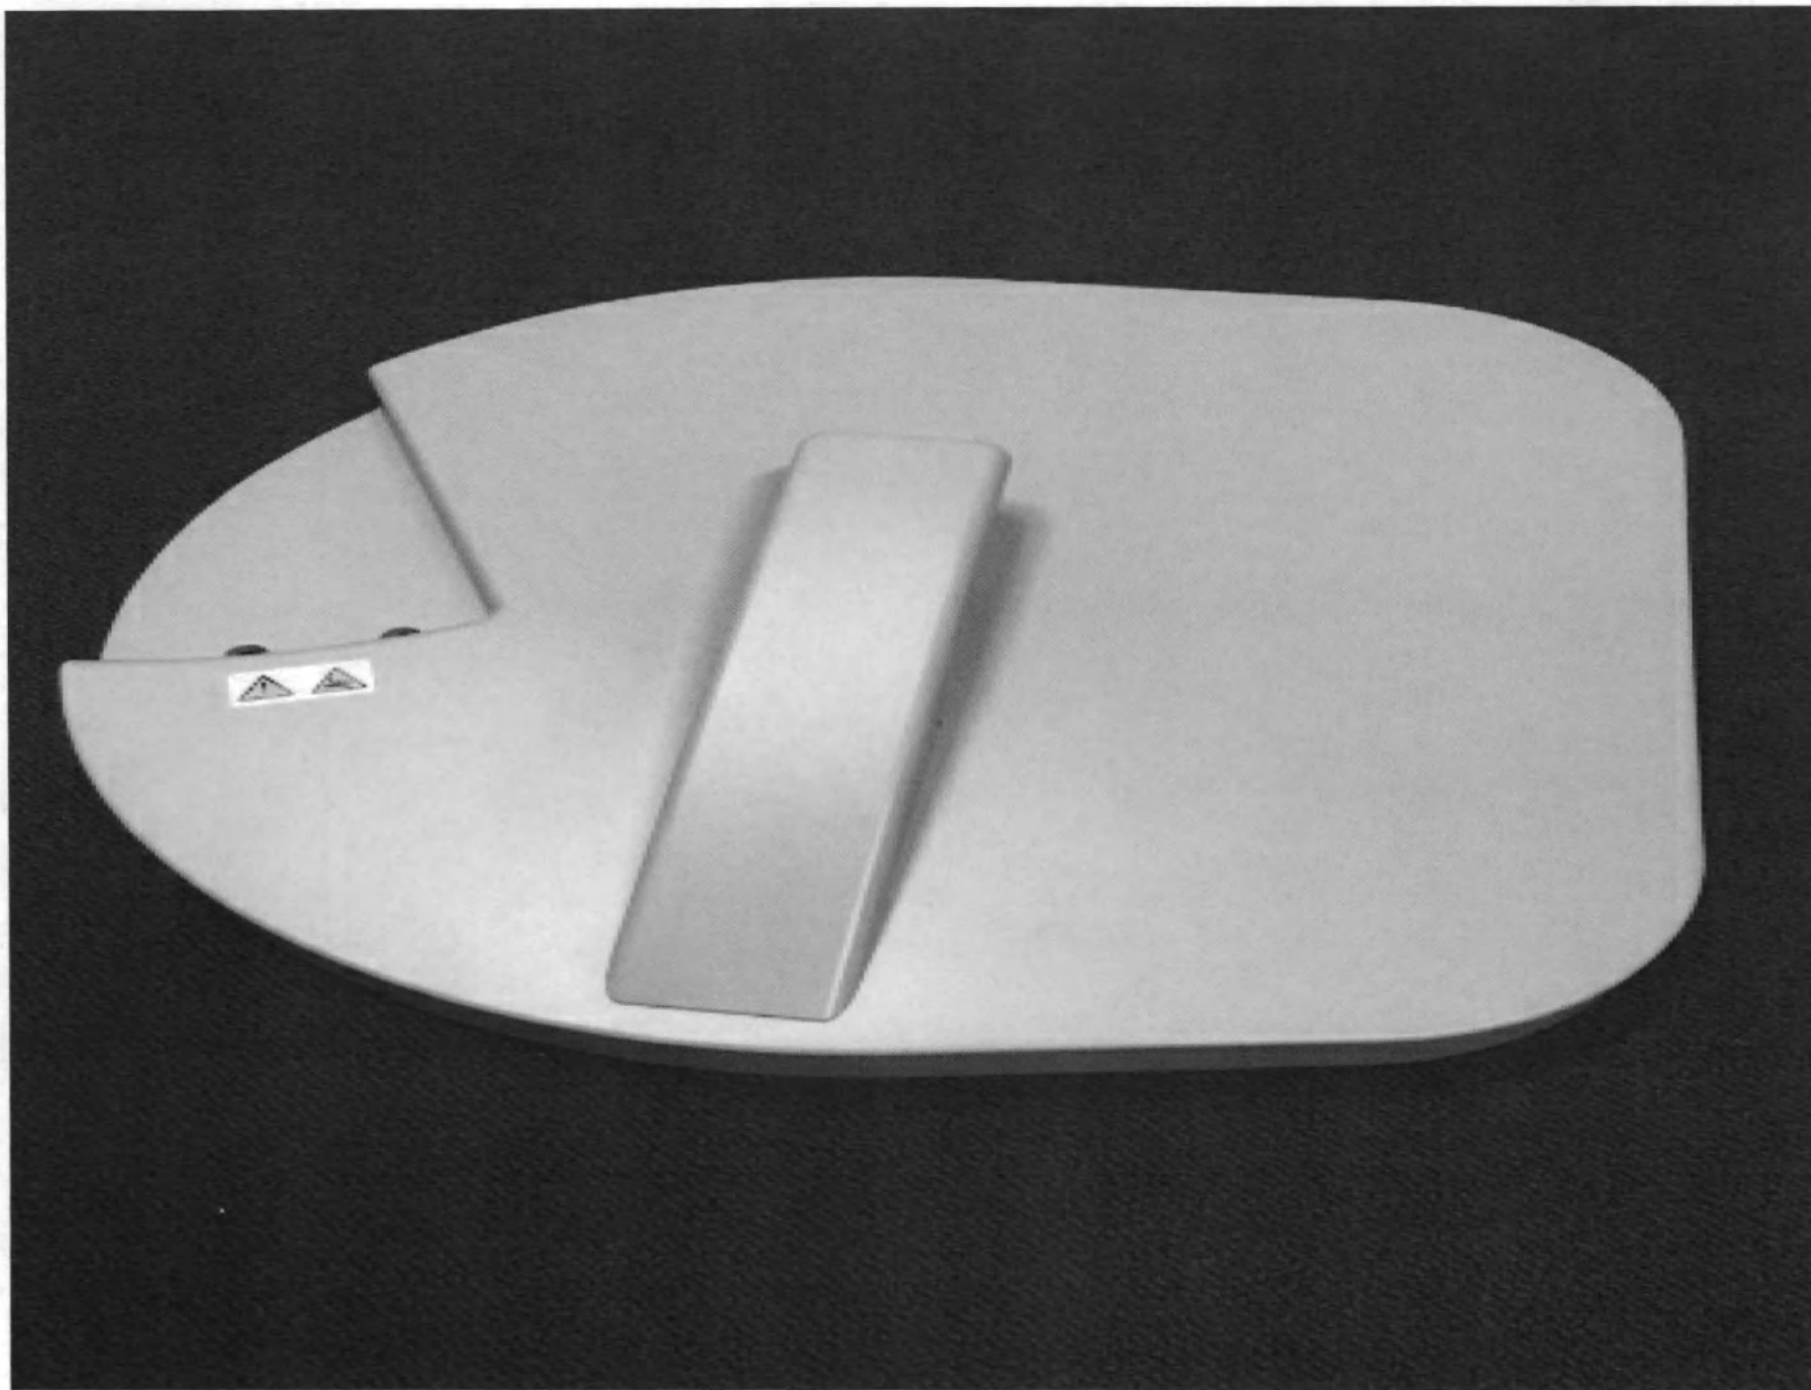


Рисунок 63

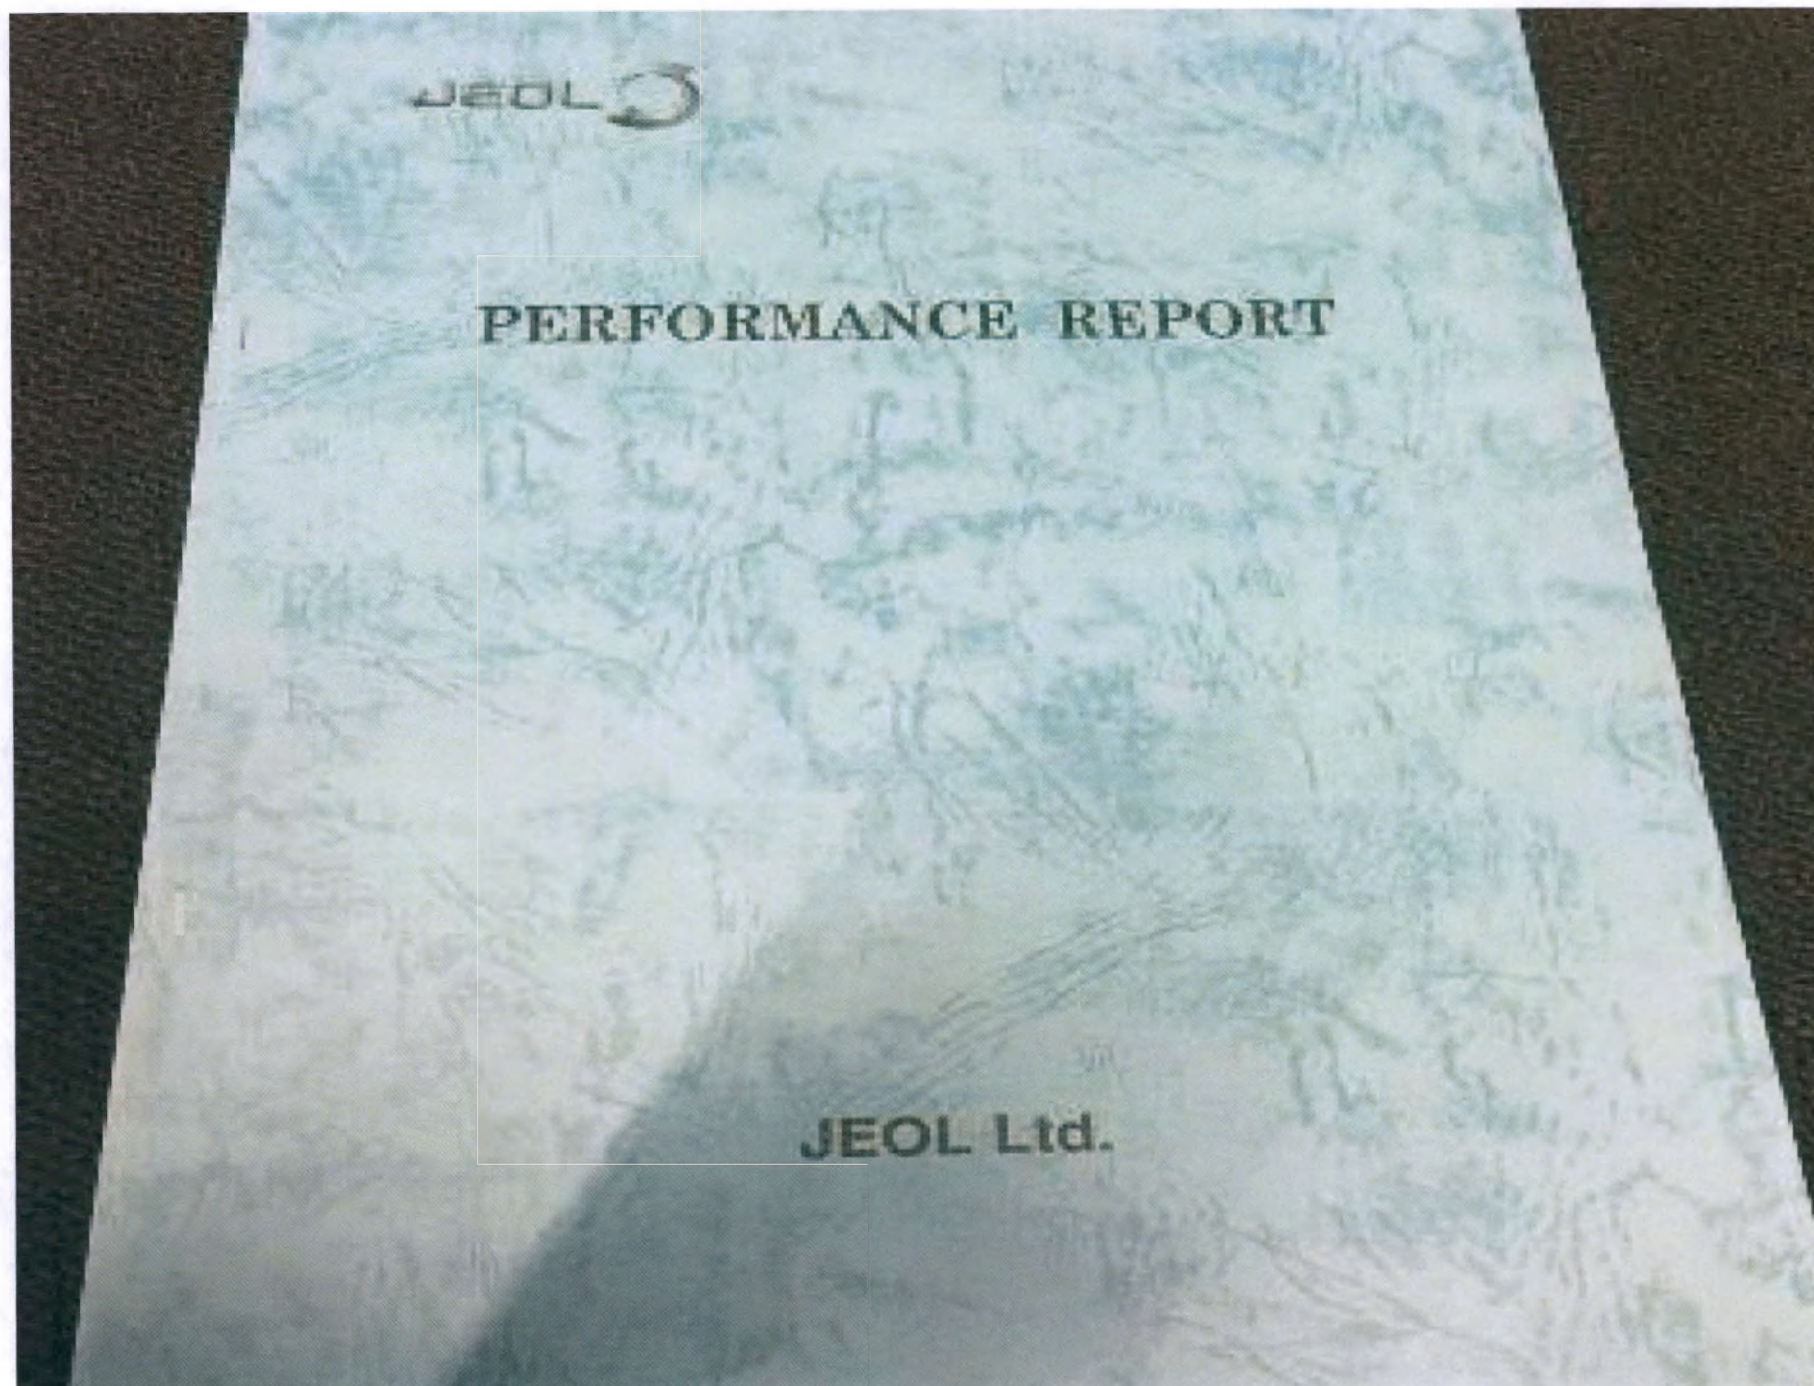


Рисунок 64

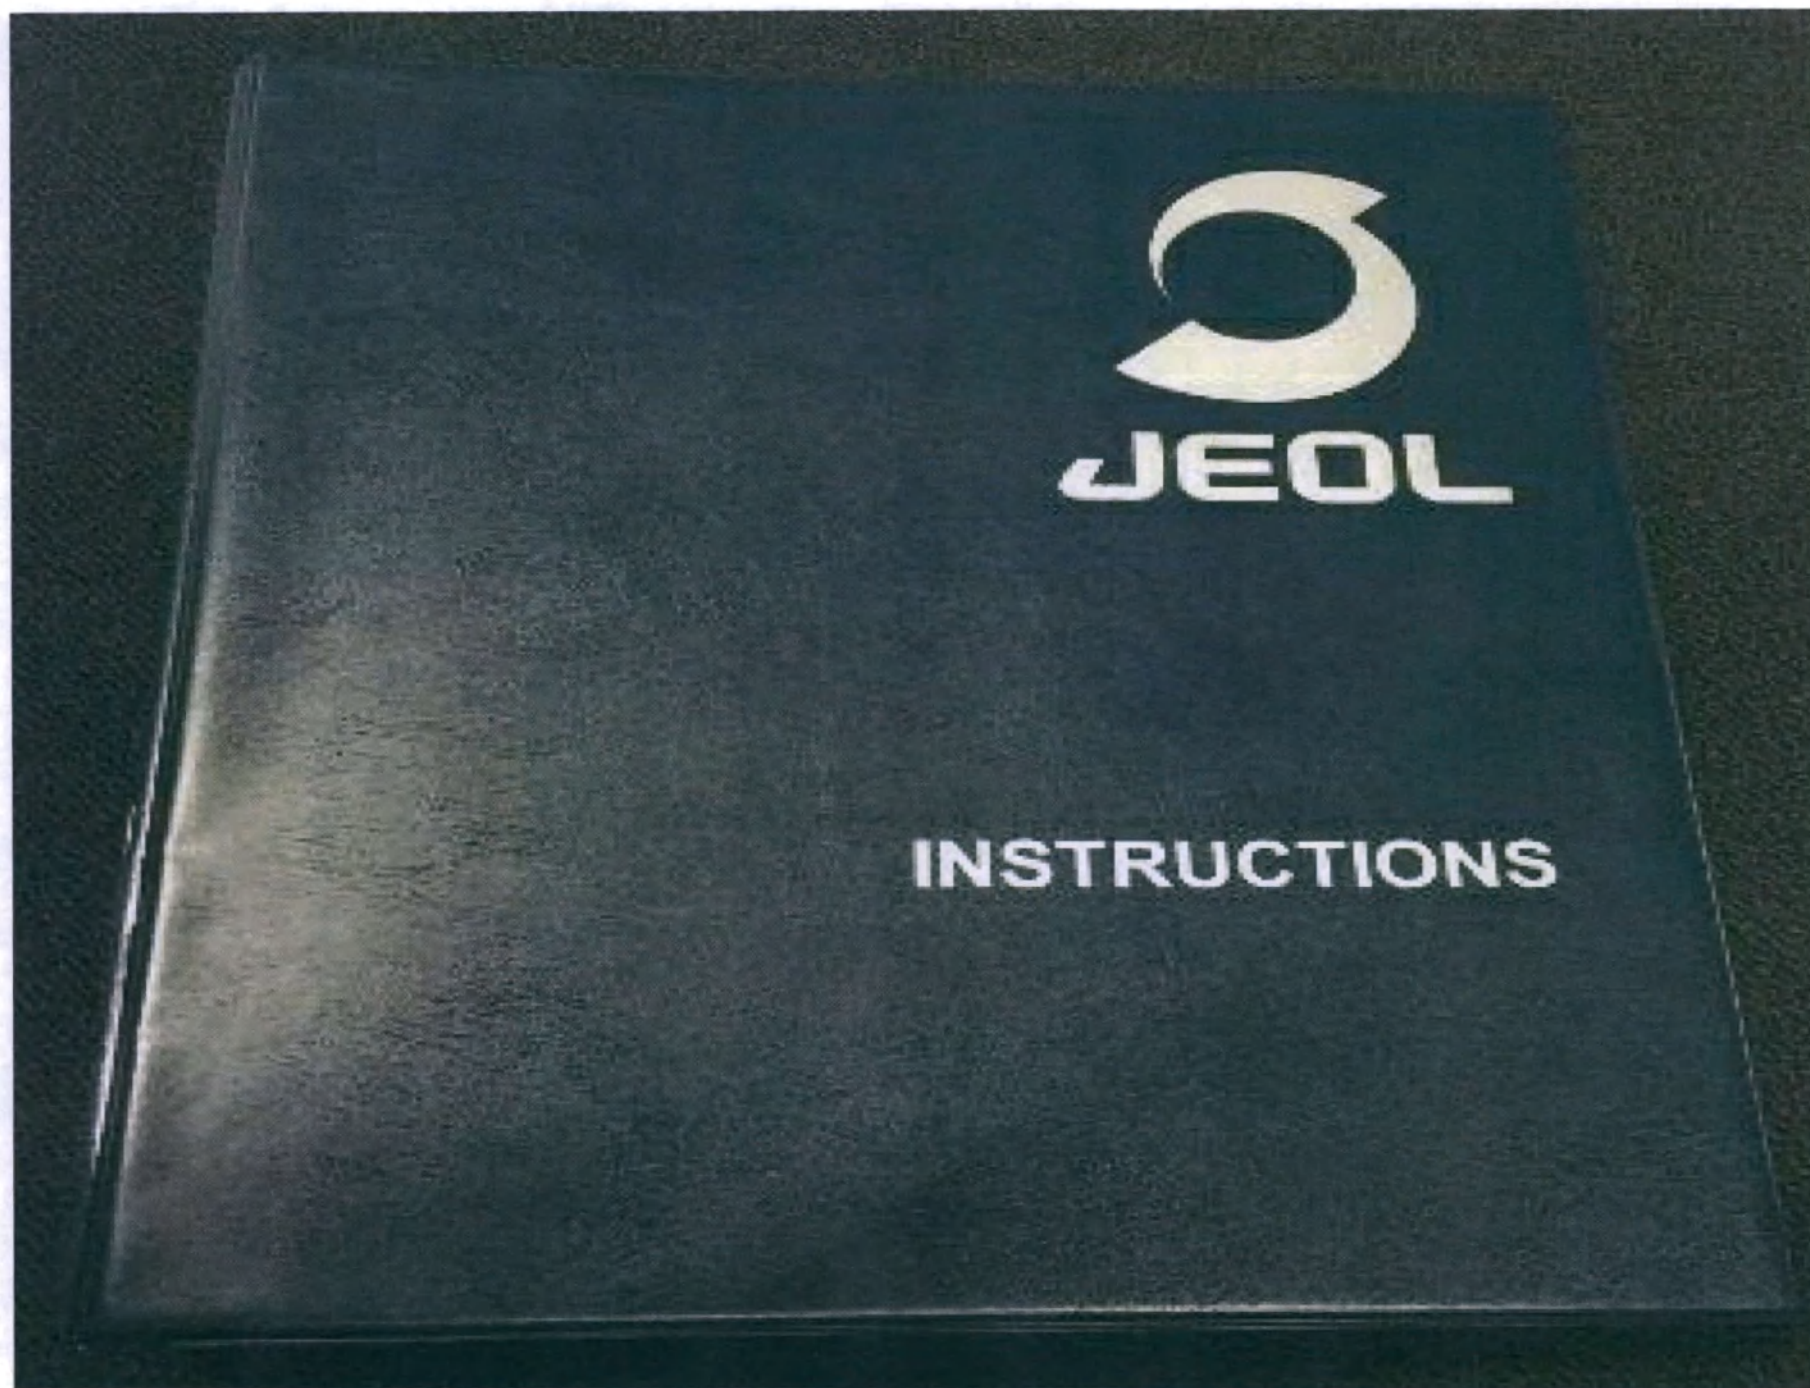


Рисунок 65



Рисунок 66



Рисунок 67



Рисунок 68

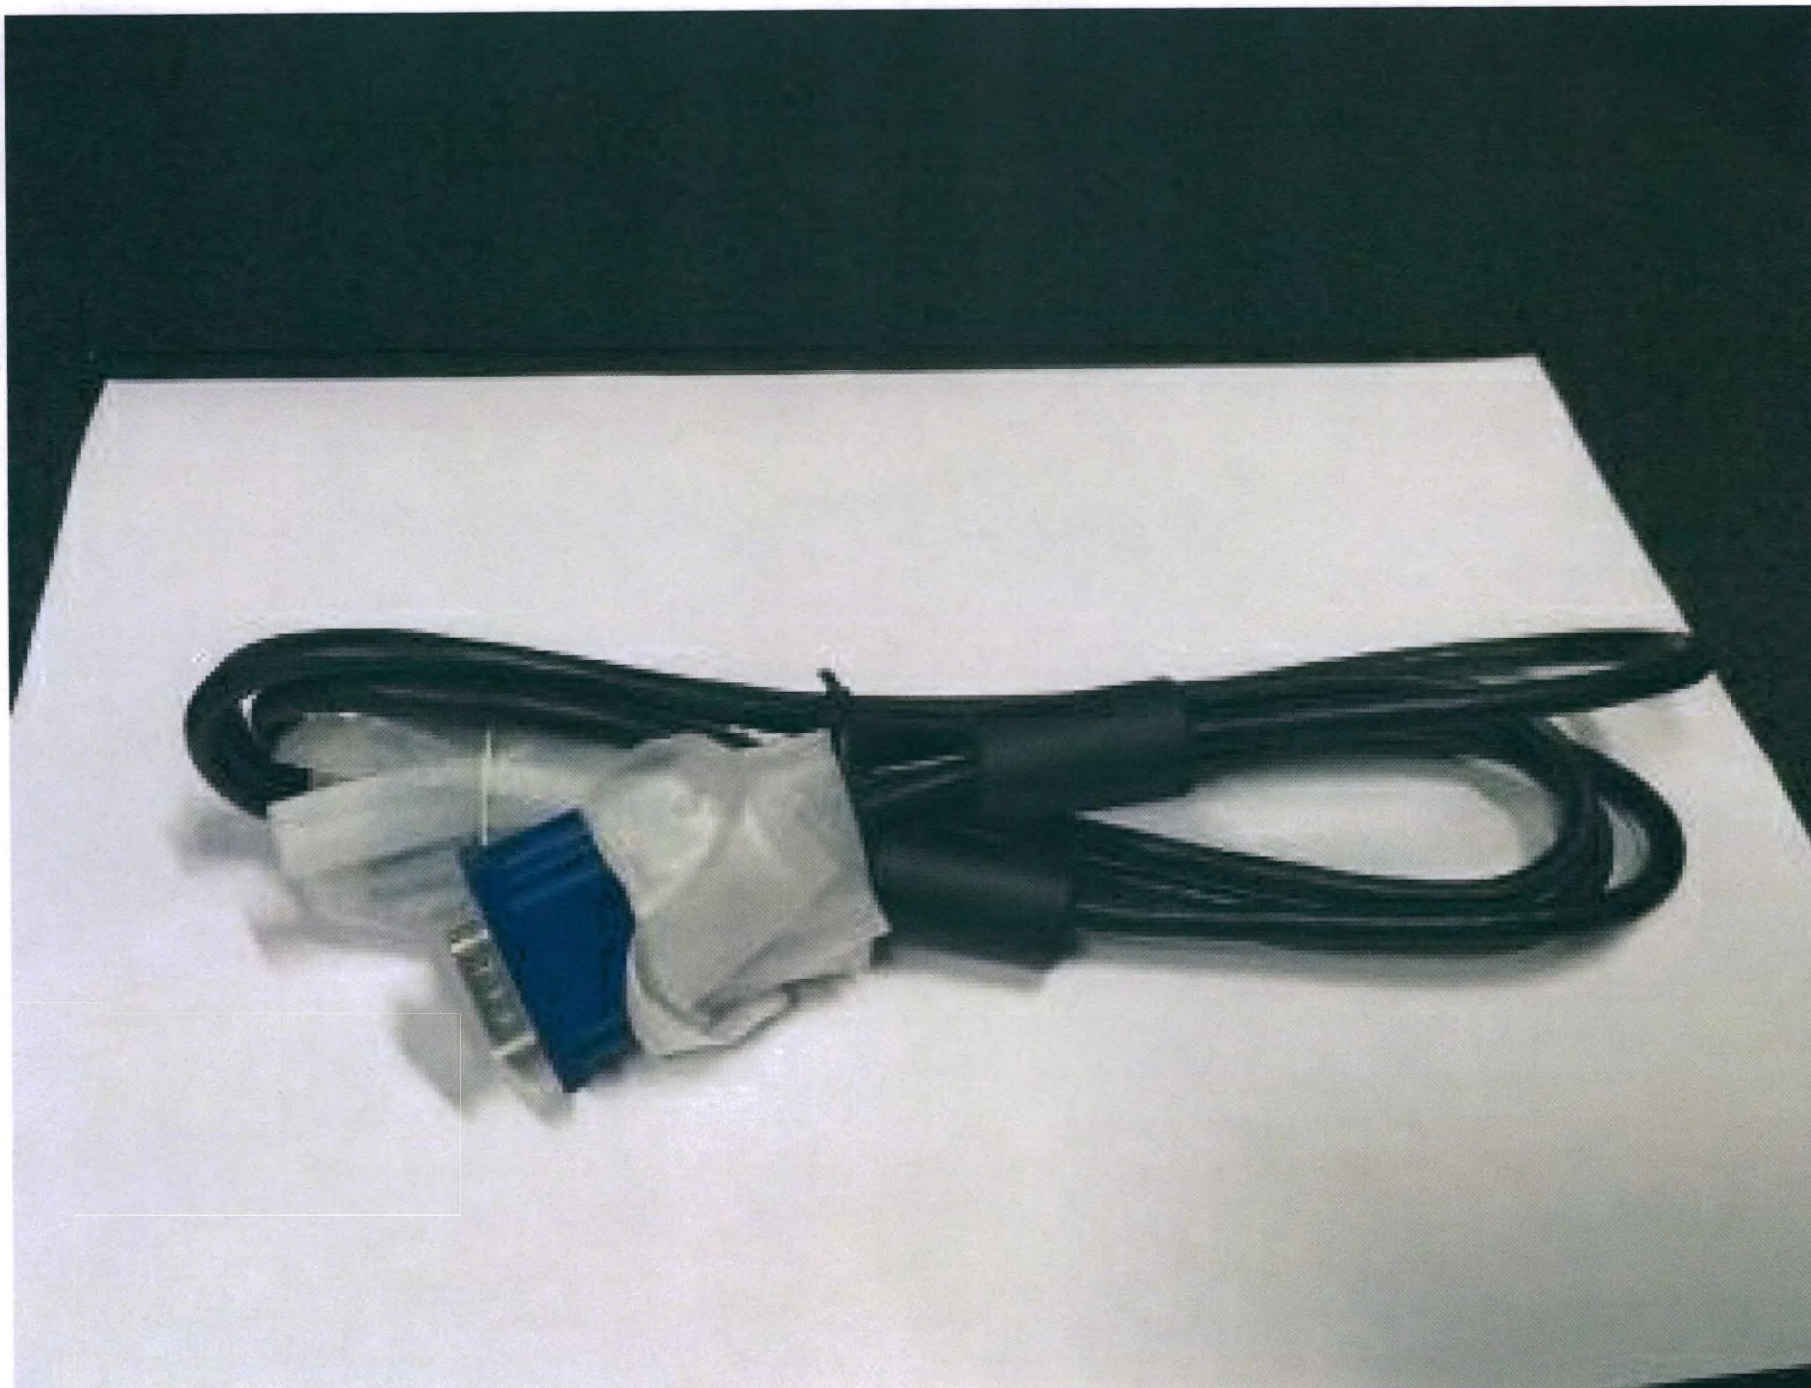


Рисунок 69

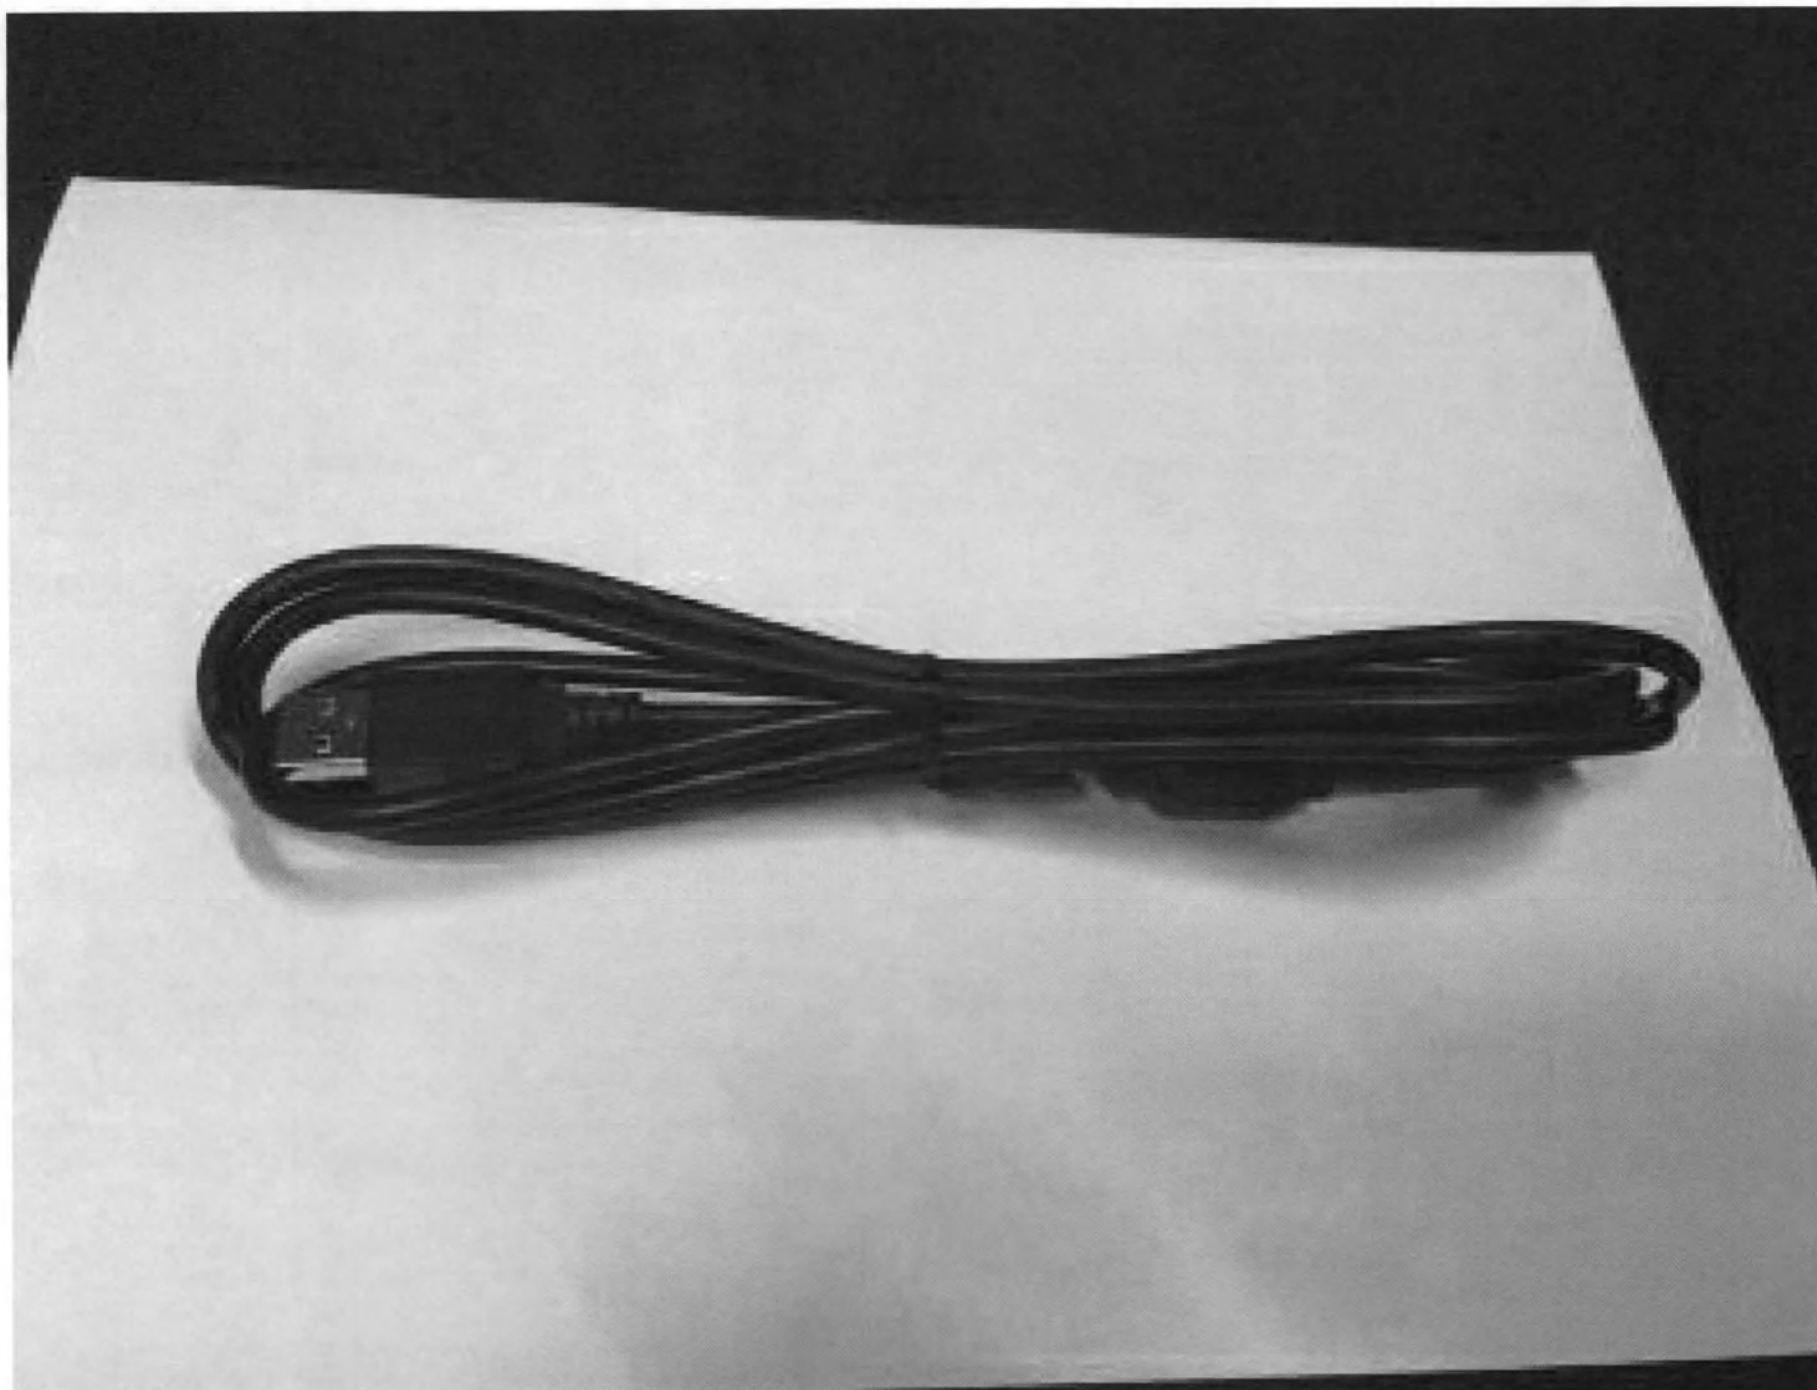


Рисунок 70

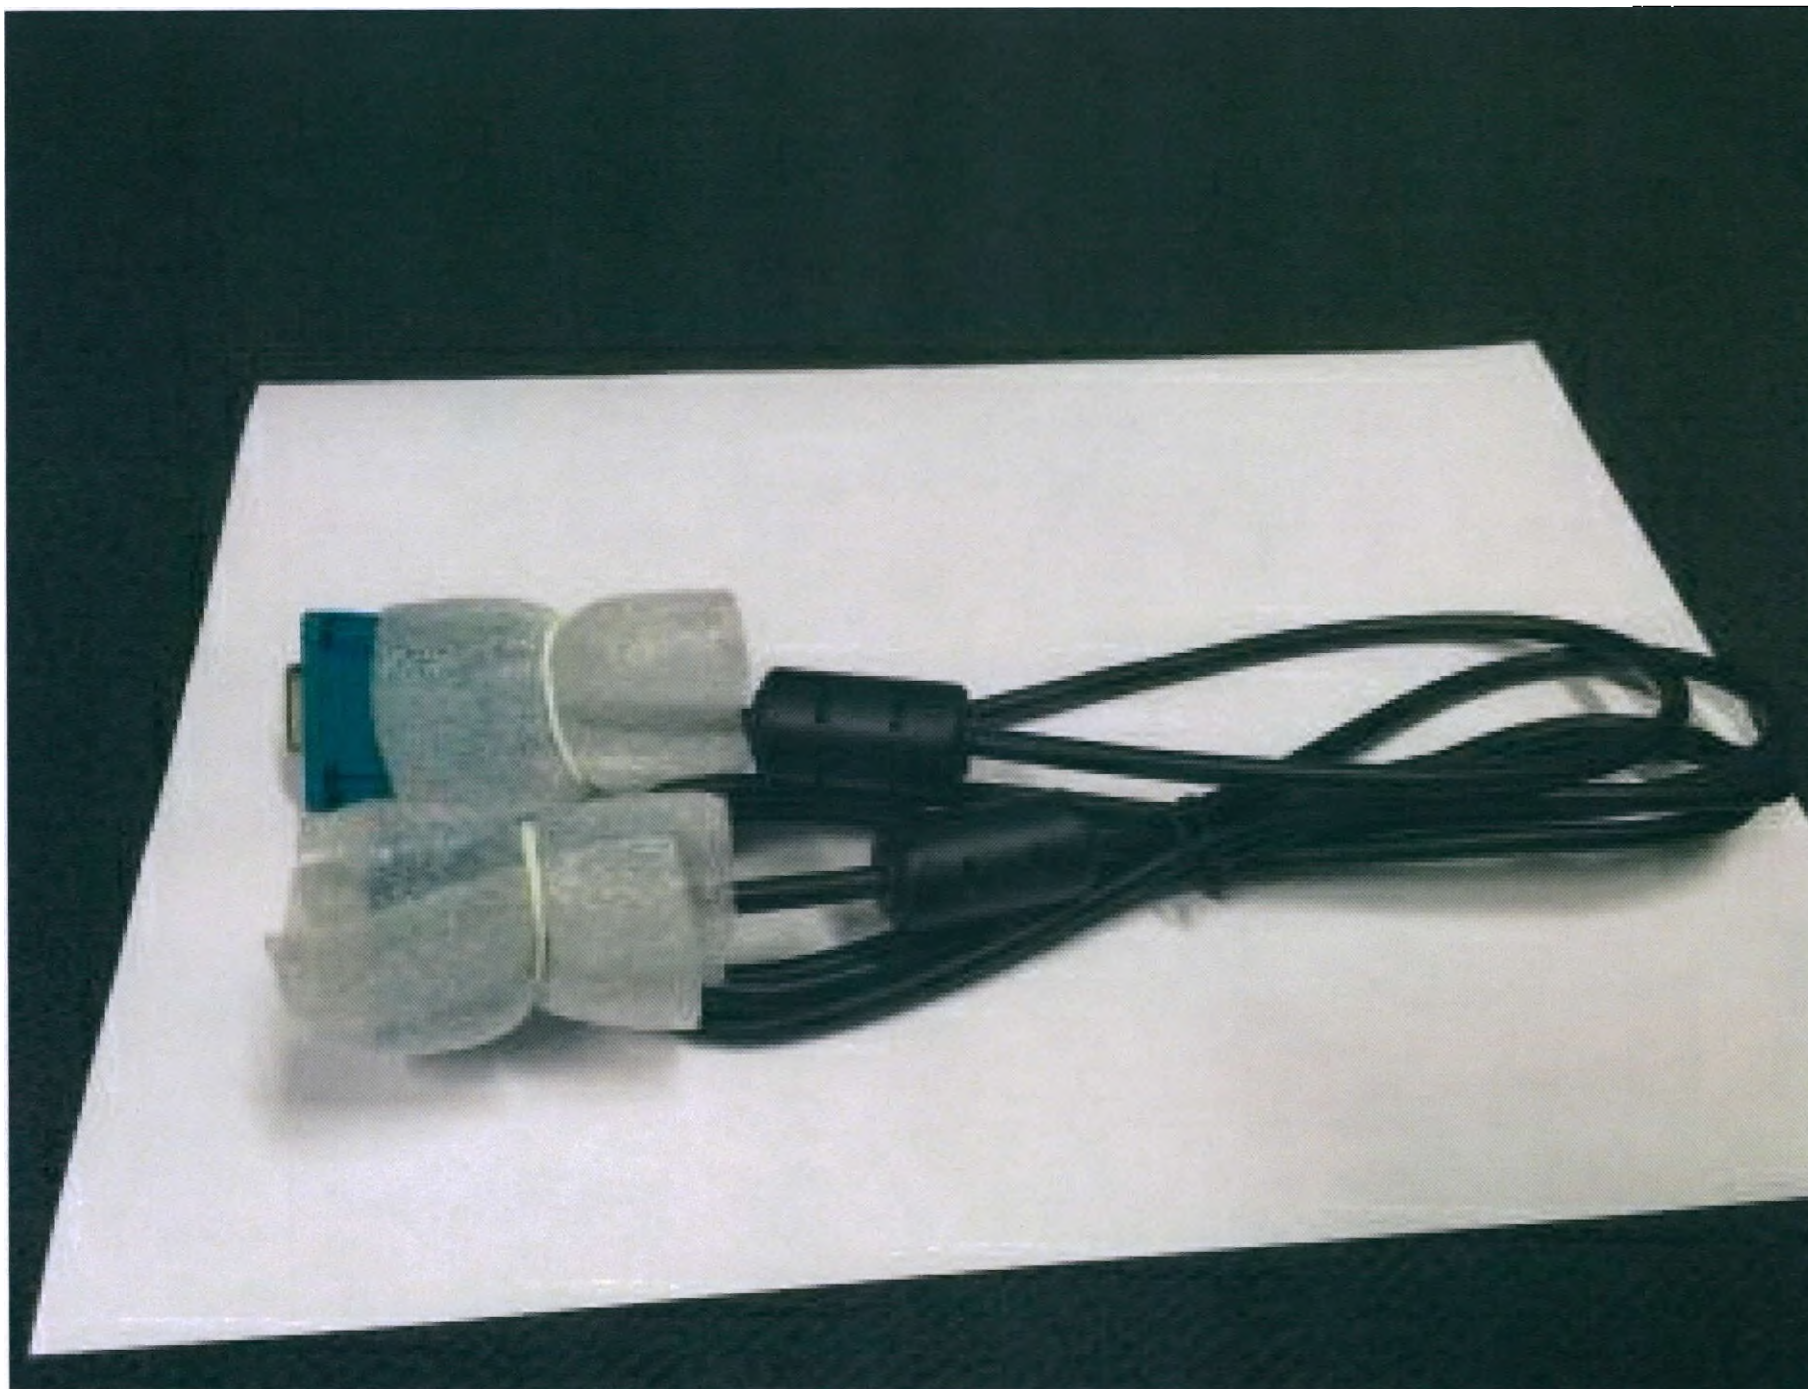


Рисунок 71

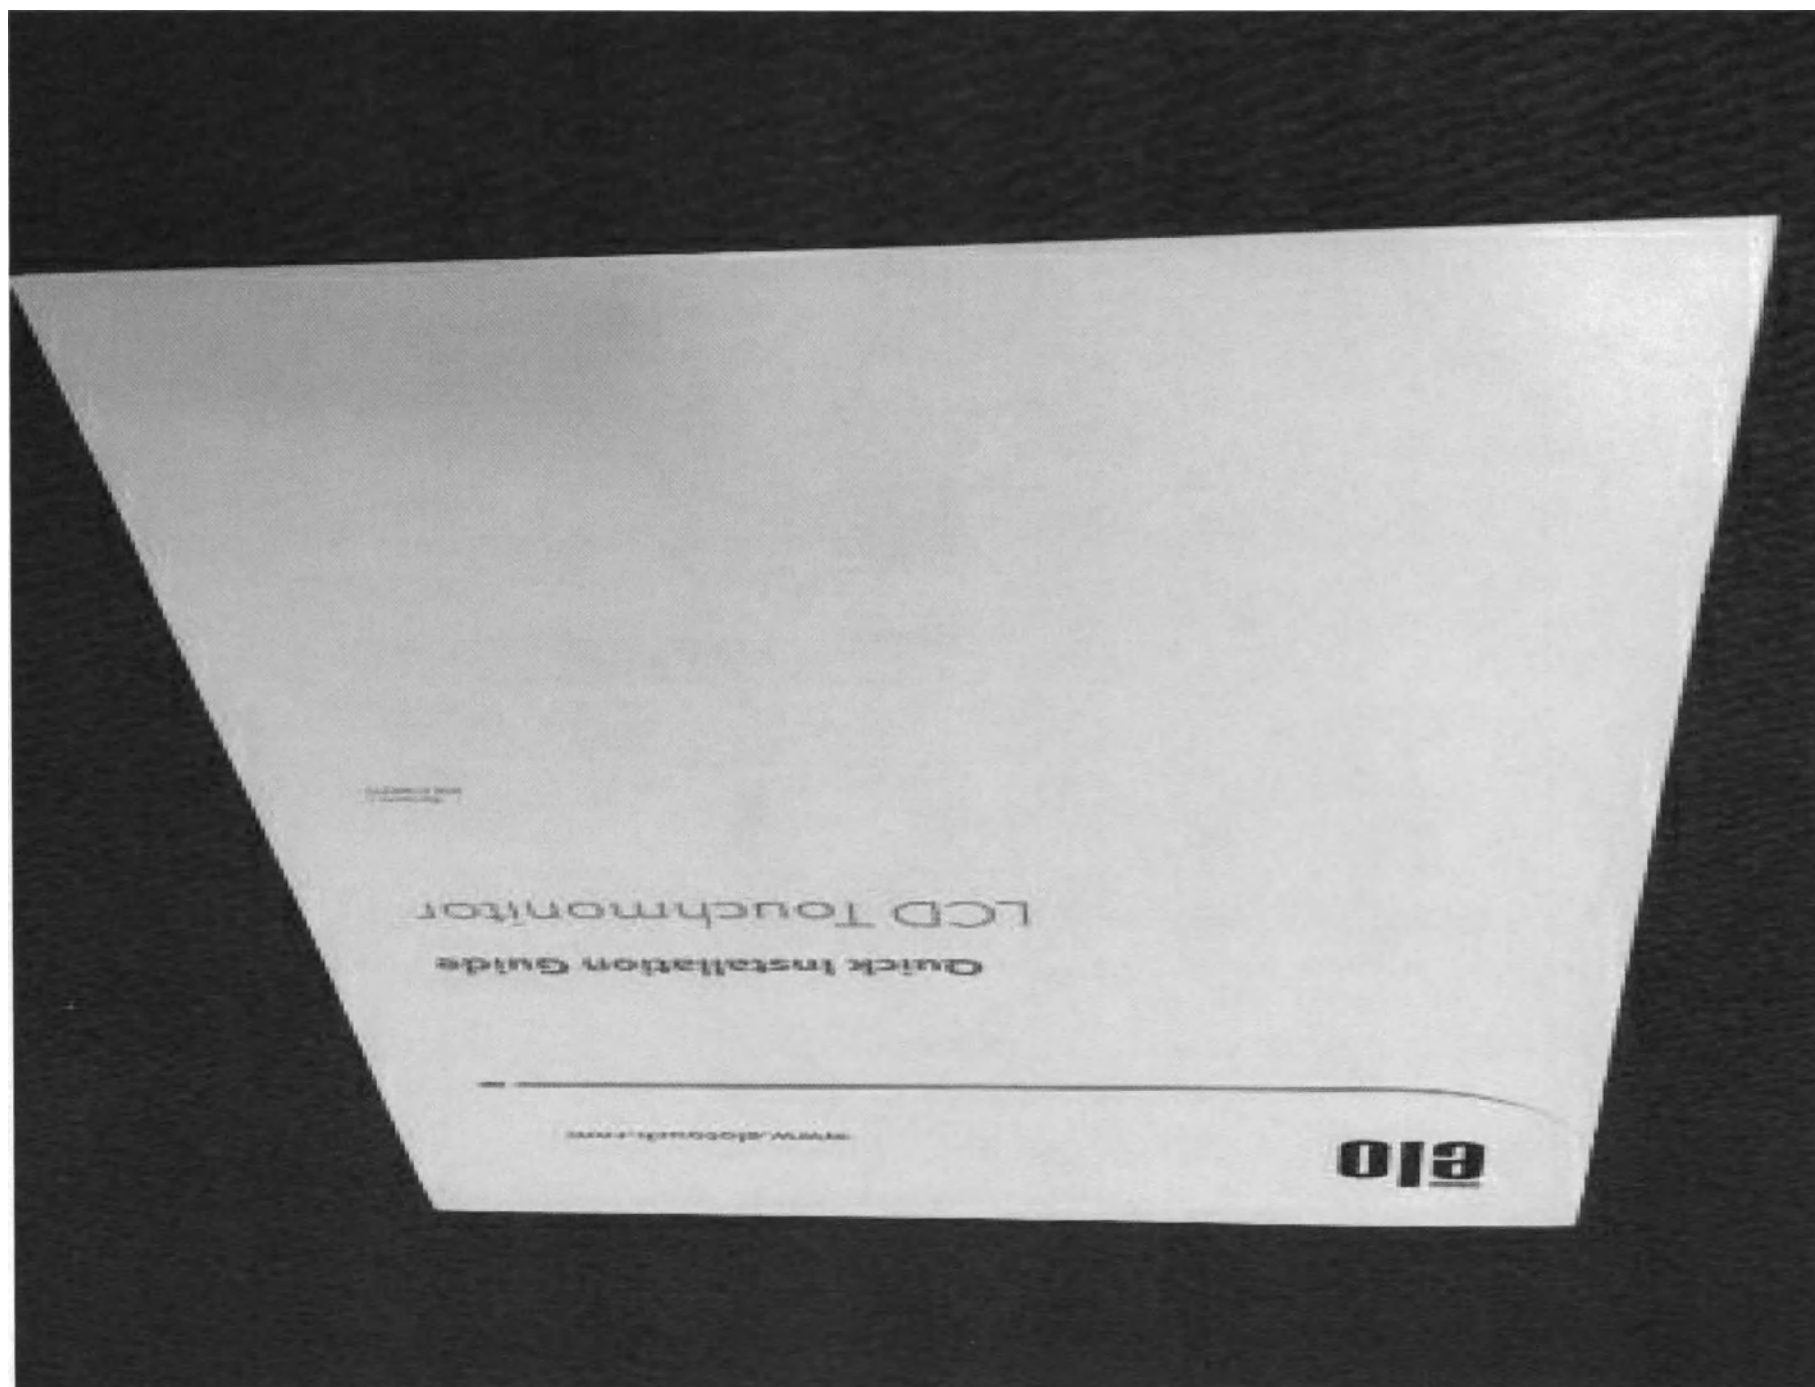




Рисунок 73

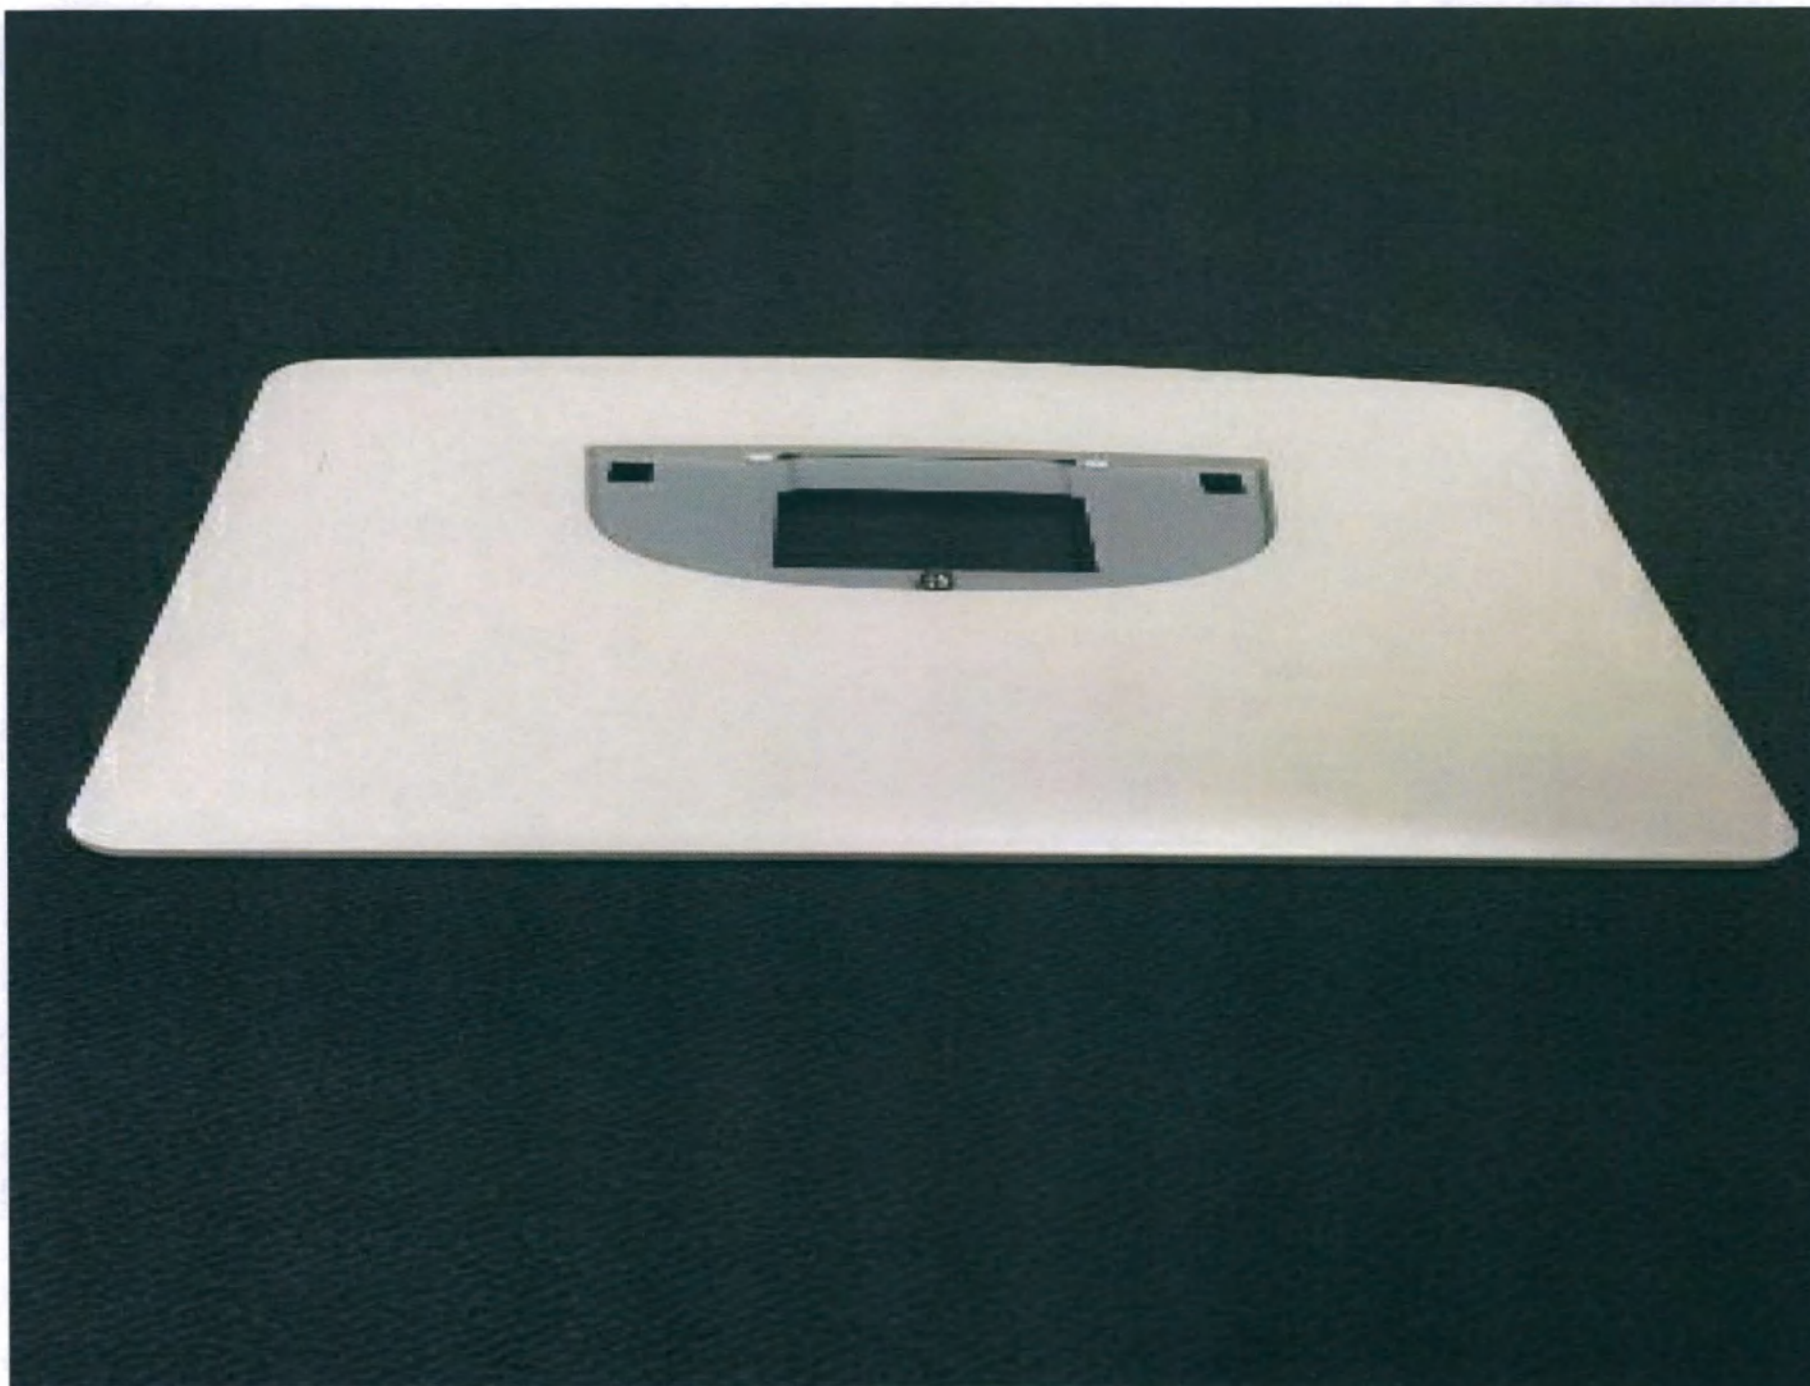


Рисунок 74



Рисунок 75



Рисунок 76



Рисунок 77



Рисунок 78

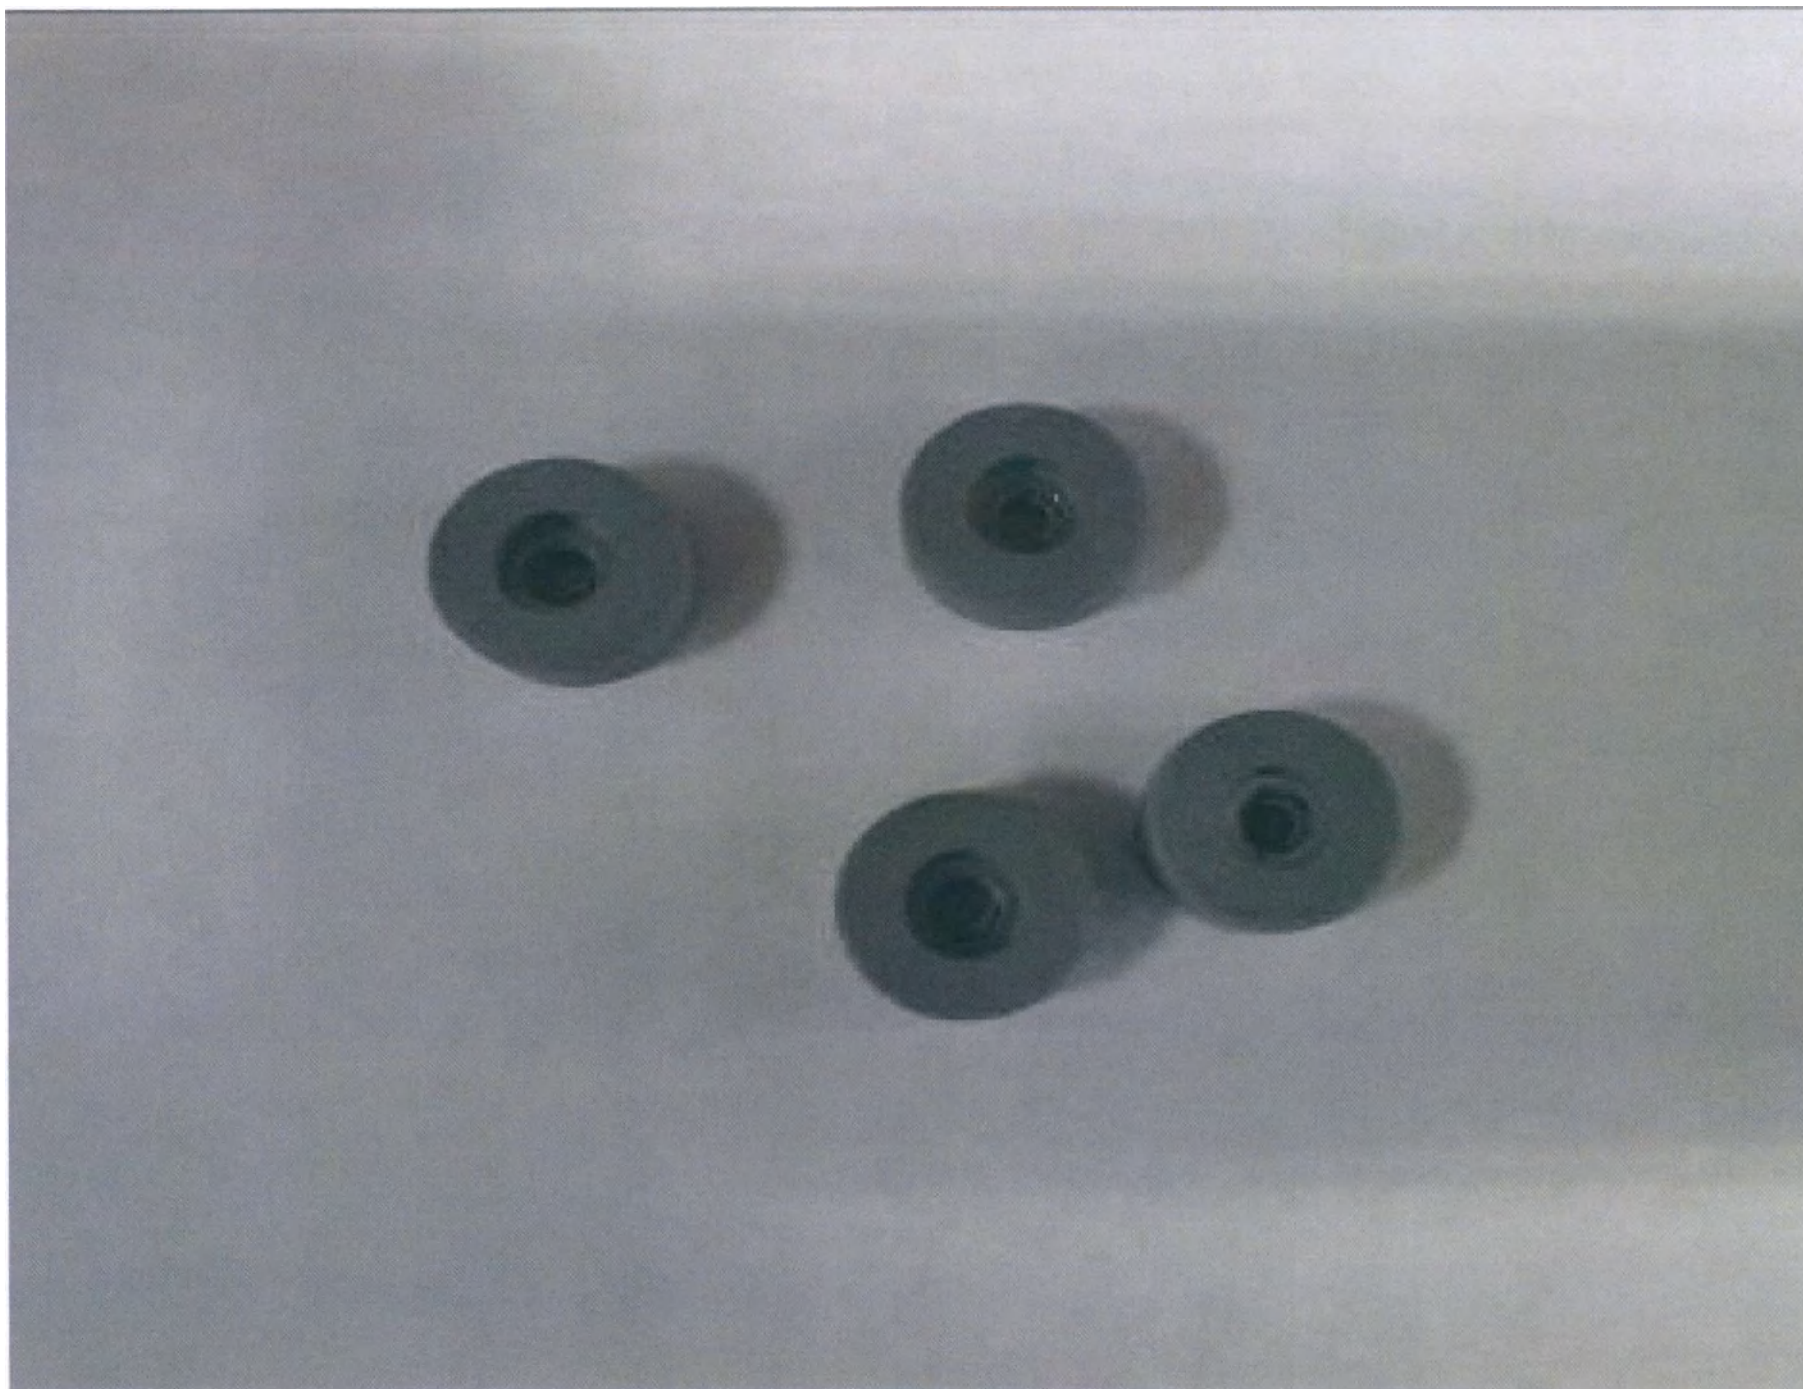


Рисунок 79



Рисунок 80



株式会社ダックス

検査成績書

製造、検査：
株式会社トライターム

製品番号：FAU-123-04

数量：1

シリアル No 部品 Rev：

 U19F0001 A

	確認	印 出
		

1	部品外観検査	外観検査基準による	良
2	機能検査	各検査項目に合格すること	良

Рисунок 81

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7

These license terms are an agreement between you and DUK Inc. Please read them. They apply to the software included on this device. The software also includes any separate media on which you received the software.

The terms also apply to any Microsoft software included on this device licensed from Microsoft Corporation or its affiliates.

- updates,
- supplements,
- Internet-based services, and
- support services.

For this software, unless other terms accompany those items, if so, those terms apply. If you obtain updates or supplements directly from Microsoft, then Microsoft, and not DUK Inc., licenses those to you.

As described below, using the software also operates as your consent to the transmission of certain computer information for Internet-based services.

By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use the software. Instead, contact DUK Inc. to determine its return policy for a refund or credit.

If you comply with these license terms, you have the rights below.

1. USE RIGHTS

Use. The software license is permanently assigned to the device with which you acquired the software. You may use the software on the device.

2. ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS

- a. Specific Use.** DUK Inc. designed the device for a specific use. You may only use the software for that use.

- b. Other Software.** You may use other programs with the software as long as the other programs directly supports the manufacturer's specific use for the device, or

- provide system utilities, resource management, or anti-virus or similar protection.
- Software that provides consumer or business tasks or processes may not be run on the device. This includes email, word processing, spreadsheet, database, scheduling and personal finance software. The device may use terminal services protocols to access such software running on a server.

- c. Device Connections.** You may not use the software as server software. In other words, more than one device may not access, display, run, share or use the software at the same time.

You may use terminal services protocols to connect the device to a server running business task or processes software such as email, word processing, scheduling or spreadsheets.

You may allow up to ten other devices to access the software to use

- File Services,
- Print Services,



Рисунок 83



Рисунок 84



Рисунок 85



Рисунок 86



Рисунок 87

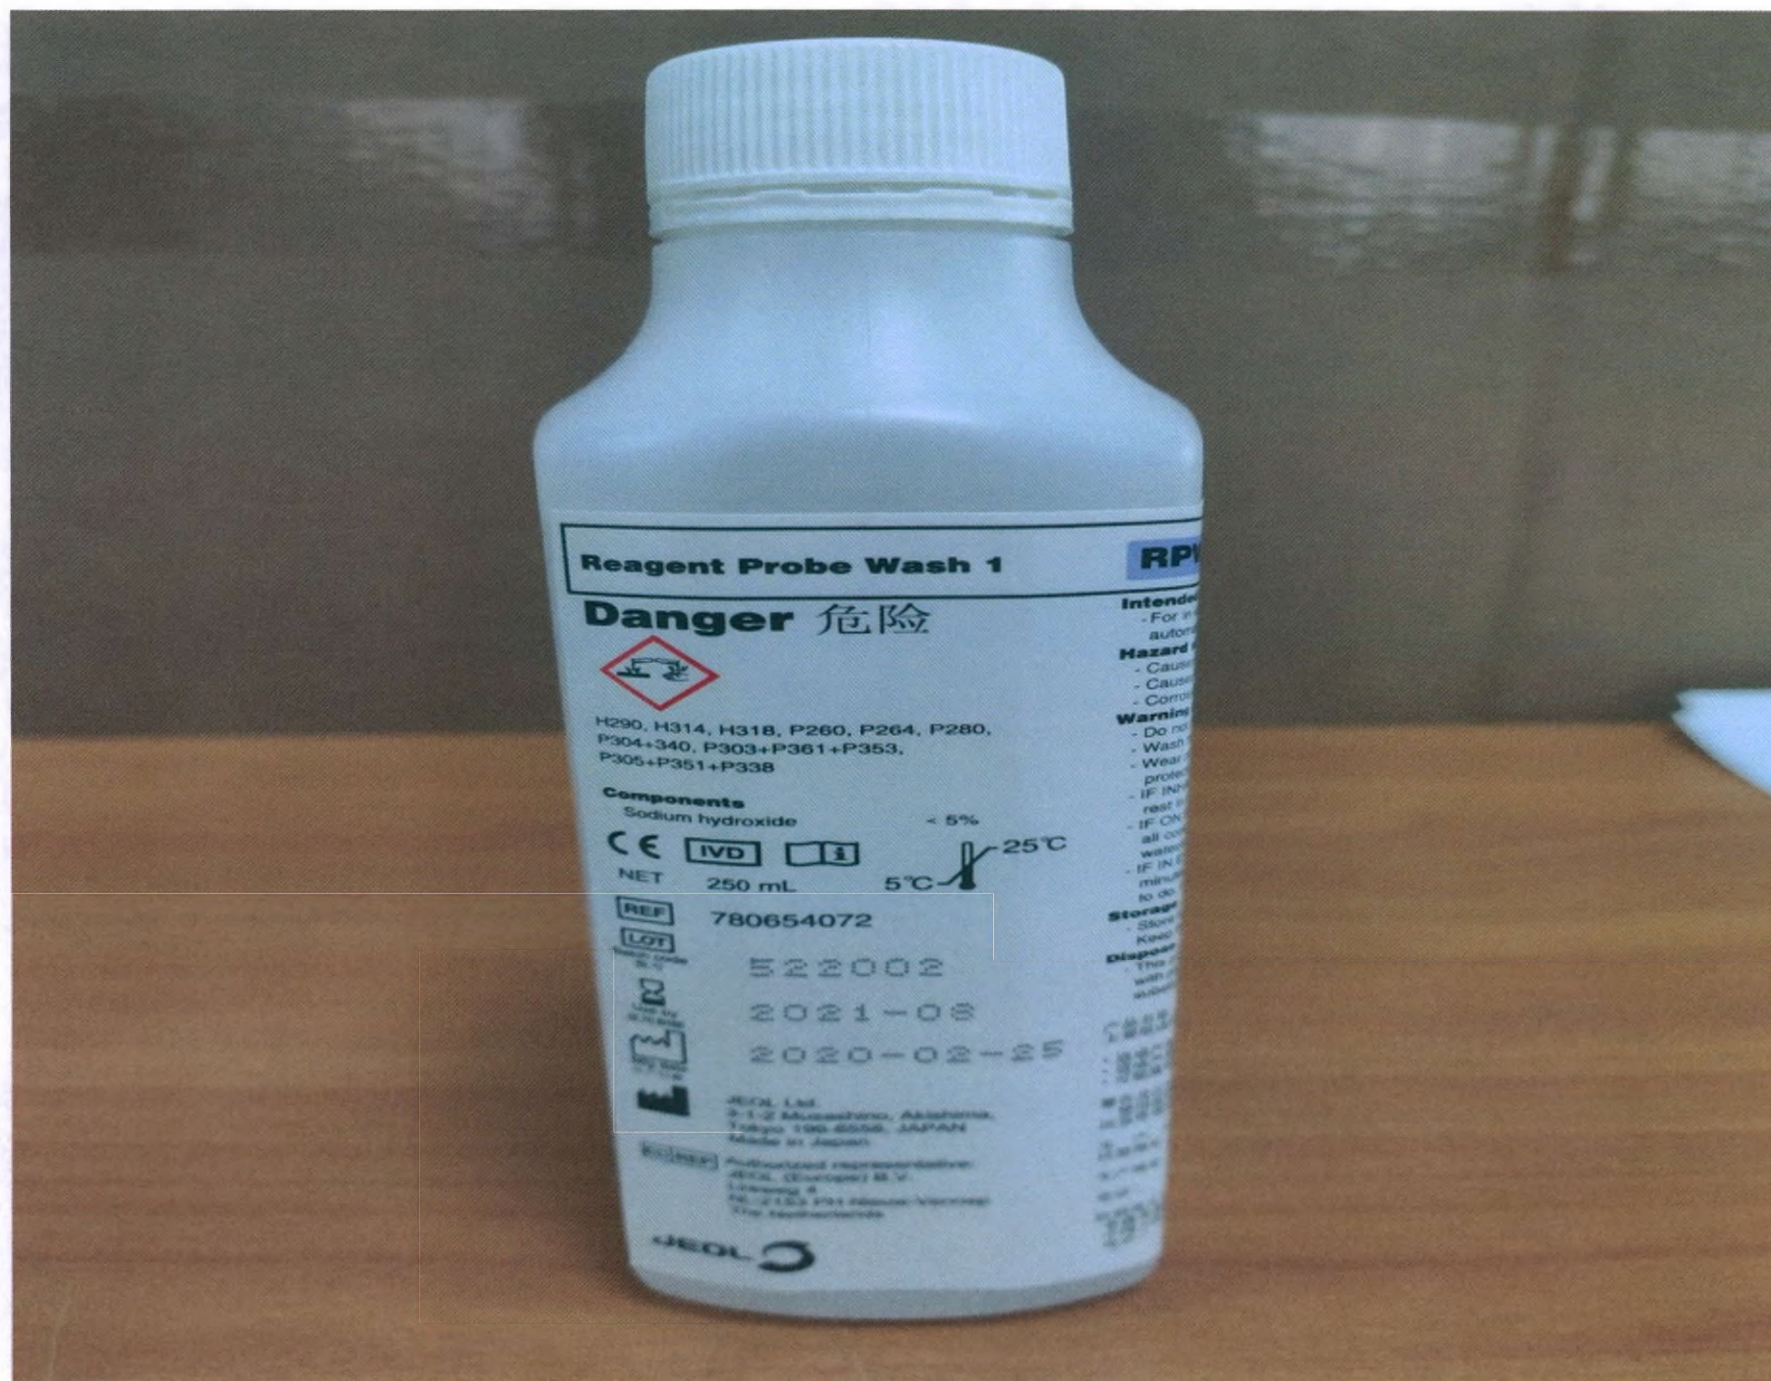


Рисунок 89


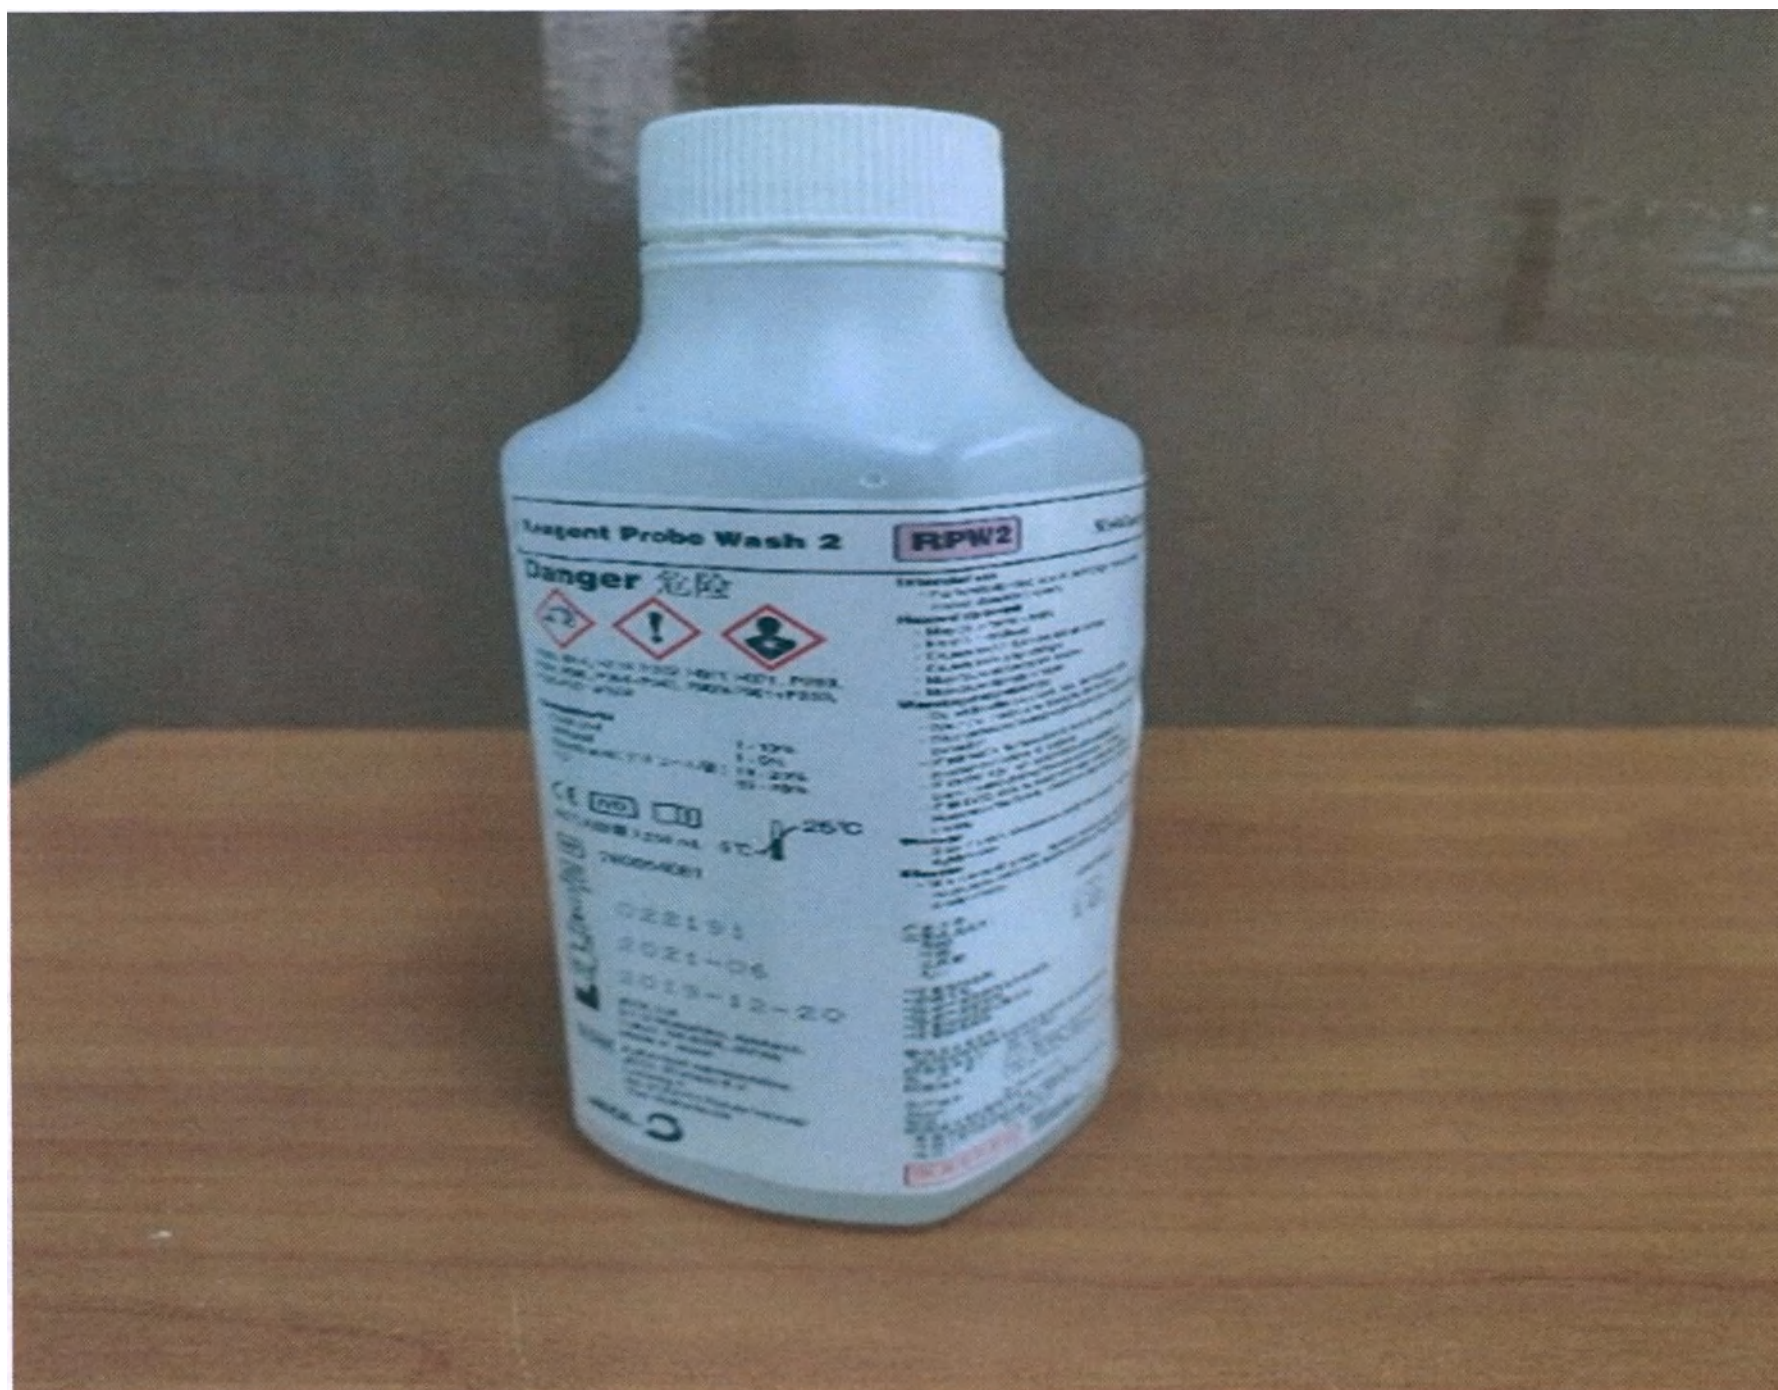


Рисунок 90

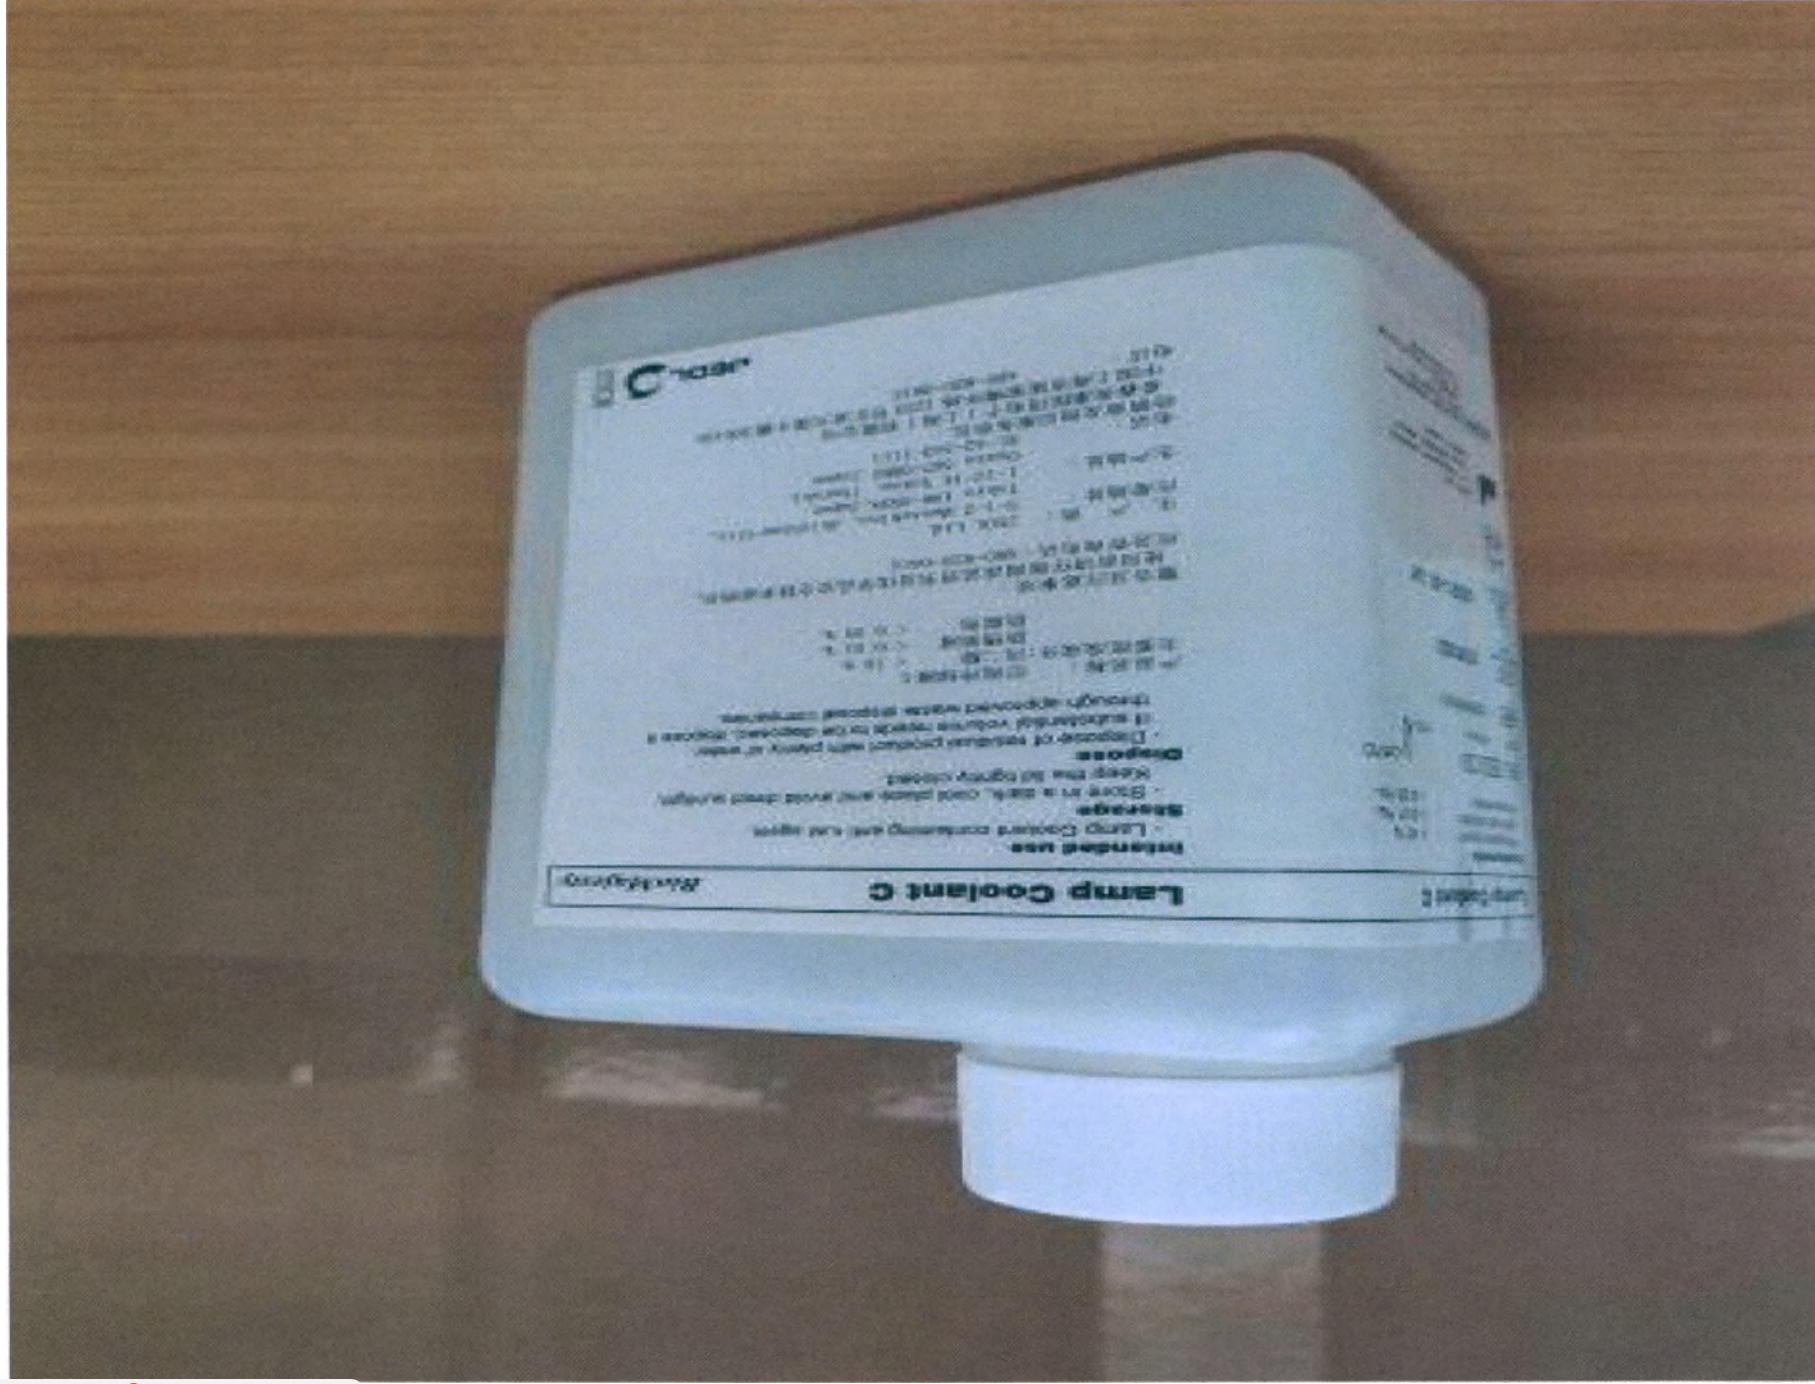

Cuvette Conditioner 3

Intended use
- For in vitro diagnostic use as a cleaning agent on automatic clinical chemistry analyzers.

Hazard statement
- May cause an allergic skin reaction.

Prevention
- Wear protective gloves/protective clothing/protective eyewear/protective mask.
- Avoid breathing vapors/spray/mist/aerosol.
- Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- Immediately remove contaminated clothing if water and soap.
- If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
- Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Product name: 比色液清洗液 3
主要组成成分: 表面活性剂

可避免或减轻过激反应:
- 使用清水充分彻底清洗皮肤及衣物并彻底冲洗。

警告及注意事项:
- 避免接触皮肤及眼睛。
危险等级: H317
危险等级代码: H317
危险等级描述: 可能引起过敏反应。

生产厂商: JEOL Ltd.
生产地址: 1-1-1, Kasugakino, Kasugakino City, Tokyo, 188-8501, Japan
经销商: 1-1-1, Kasugakino, Kasugakino City, Tokyo, 188-8501, Japan
经销商电话: 03-5445-1111
经销商地址: 1-1-1, Kasugakino, Kasugakino City, Tokyo, 188-8501, Japan
经销商名称: JEOL Ltd.

JEOL

Cuvette Conditioner 3

Warning 警告

Intended use
- For in vitro diagnostic use as a cleaning agent on automatic clinical chemistry analyzers.

Hazard statement
- May cause an allergic skin reaction.

Prevention
- Wear protective gloves/protective clothing/protective eyewear/protective mask.
- Avoid breathing vapors/spray/mist/aerosol.
- Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- Immediately remove contaminated clothing if water and soap.
- If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
- Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Product name: 比色液清洗液 3
主要组成成分: 表面活性剂

可避免或减轻过激反应:
- 使用清水充分彻底清洗皮肤及衣物并彻底冲洗。

警告及注意事项:
- 避免接触皮肤及眼睛。
危险等级: H317
危险等级代码: H317
危险等级描述: 可能引起过敏反应。

生产厂商: JEOL Ltd.
生产地址: 1-1-1, Kasugakino, Kasugakino City, Tokyo, 188-8501, Japan
经销商: 1-1-1, Kasugakino, Kasugakino City, Tokyo, 188-8501, Japan
经销商电话: 03-5445-1111
经销商地址: 1-1-1, Kasugakino, Kasugakino City, Tokyo, 188-8501, Japan
经销商名称: JEOL Ltd.

JEOL



Рисунок 96




Рисунок 97



Рисунок 98



Na⁺ Sodium Electrode**BioMajesty™****Intended use**

- Sodium electrode is ion selective electrode that is intended for use on the ion selective electrode (ISE) unit incorporated in the automatic clinical chemistry analyzers supplied by JEOL.
- Sodium electrode is used to quantify the concentrations of sodium ions in serum, plasma and urine.

Storage

- Storage conditions : Store in a tight container at 2-32 degrees Celsius.

Dispose


- Observe all federal, state and local environmental regulations

产品名称： 钠电极
 警告及注意事项： 使用前请仔细阅读说明书。
 应急咨询电话： 400-820-0815
 生产商： JEOL Ltd.
 注册地址： 3-1-2 Musashino, Akishima-City,
 Tokyo 196-8558, Japan
 生产地址： 2023-1, Endo Fujisawa-shi,
 Kanagawa 252-0816, Japan
 电话： 81-42-543-1111
 经销商及售后服务单位：
 希森美康医用电子（上海）有限公司
 中国上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦9楼200120
 电话： 400-820-0815

 JEOL Ltd.
 3-1-2 Musashino,
 Akishima,
 Tokyo 196-8558, Japan
 Made in Japan

EC REP Authorized representative:
 JEOL (Europe) B.V.
 Lirweg 4
 NL-2153 PH Nieuw-Vennep
 The Netherlands

Potassium Electrode



BioMajesty™

Intended use

- Potassium electrode is ion selective electrode that is intended for use on the ion selective electrode (ISE) unit incorporated in the automatic clinical chemistry analyzers supplied by JEOL.
- Potassium electrode is used to quantify the concentrations of potassium ions in serum, plasma and urine.

Storage

- Storage conditions : Store in a tight container at 2-32 degrees Celsius.

Dispose

- Observe all federal, state and local environmental regulations

产品名称： 钾电极
 警告及注意事项： 使用前请仔细阅读说明书。
 应急咨询电话： 400-820-0815
 生产商： JEOL Ltd.
 注册地址： 3-1-2 Musashino, Akishima-City,
 Tokyo 196-8558, Japan
 生产地址： 2023-1, Endo Fujisawa-shi,
 Kanagawa 252-0816, Japan
 电话： 81-42-543-1111
 经销商及售后服务单位：
 希森美康医用电子（上海）有限公司
 中国上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 9 楼 200120
 电话： 400-820-0815




JEOL Ltd.
 3-1-2 Musashino,
 Akishima,
 Tokyo 196-8558, Japan
 Made in Japan



Authorized representative:
 JEOL (Europe) B.V.
 Lireweg 4
 NL-2153 PH Nieuw-Vennep
 The Netherlands

Cl⁻ Chloride Electrode



BioMajesty™

Intended use

- Chloride electrode is ion selective electrode that is intended for use on the ion selective electrode (ISE) unit incorporated in the automatic clinical chemistry analyzers supplied by JEOL.
- Chloride electrode is used to quantify the concentrations of chloride ions in serum, plasma and urine.

Storage

- Storage conditions : Store in a tight container at 2-32 degrees Celsius.

Dispose


- Observe all federal, state and local environmental regulations

产品名称： 氯电极
 警告及注意事项： 使用前请仔细阅读说明书。
 应急咨询电话： 400-820-0815
 生产商： JEOL Ltd.
 注册地址： 3-1-2 Musashino, Akishima-City,
 Tokyo 196-8558, Japan
 生产地址： 2023-1, Endo Fujisawa-shi,
 Kanagawa 252-0816, Japan
 电话： 81-42-543-1111
 经销商及售后服务单位：
 希森美康医用电子（上海）有限公司
 中国上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 9 楼 200120
 电话： 400-820-0815

 JEOL Ltd.
 3-1-2 Musashino,
 Akishima,
 Tokyo 196-8558, Japan
 Made in Japan

EC REP Authorized representative:
 JEOL (Europe) B.V.
 Lirweg 4
 NL-2153 PH Nieuw-Vennep
 The Netherlands

Ref. Reference Electrode



BioMajesty™

Intended use

- Reference electrode is intended for use on the ion selective electrode (ISE) unit incorporated in the automatic clinical chemistry analyzers supplied by JEOL.
- Reference electrode is used to quantify the concentrations of inorganic ions in serum, plasma and urine.

Storage


- Storage conditions : Store in a tight container at 2-32 degrees Celsius.

Dispose

- Observe all federal, state and local environmental regulations

产品名称 : 参比电极
 警告及注意事项 : 使用前请仔细阅读说明书。
 应急咨询电话 : 400-820-0815
 生产商 : JEOL Ltd.
 注册地址 : 3-1-2 Musashino, Akishima-City,
 Tokyo 196-8558, Japan
 生产地址 : 2023-1, Endo Fujisawa-shi,
 Kanagawa 252-0816, Japan
 电话 : 81-42-543-1111
 经销商及售后服务单位 : 希森美康医用电子(上海)有限公司
 中国上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 9 楼 200120
 电话 : 400-820-0815

 JEOL Ltd.
 3-1-2 Musashino,
 Akishima,
 Tokyo 196-8558, Japan
 Made in Japan

 Authorized representative:
 JEOL (Europe) B.V.
 Lireweg 4
 NL-2153 PH Nieuw-Vennep
 The Netherlands

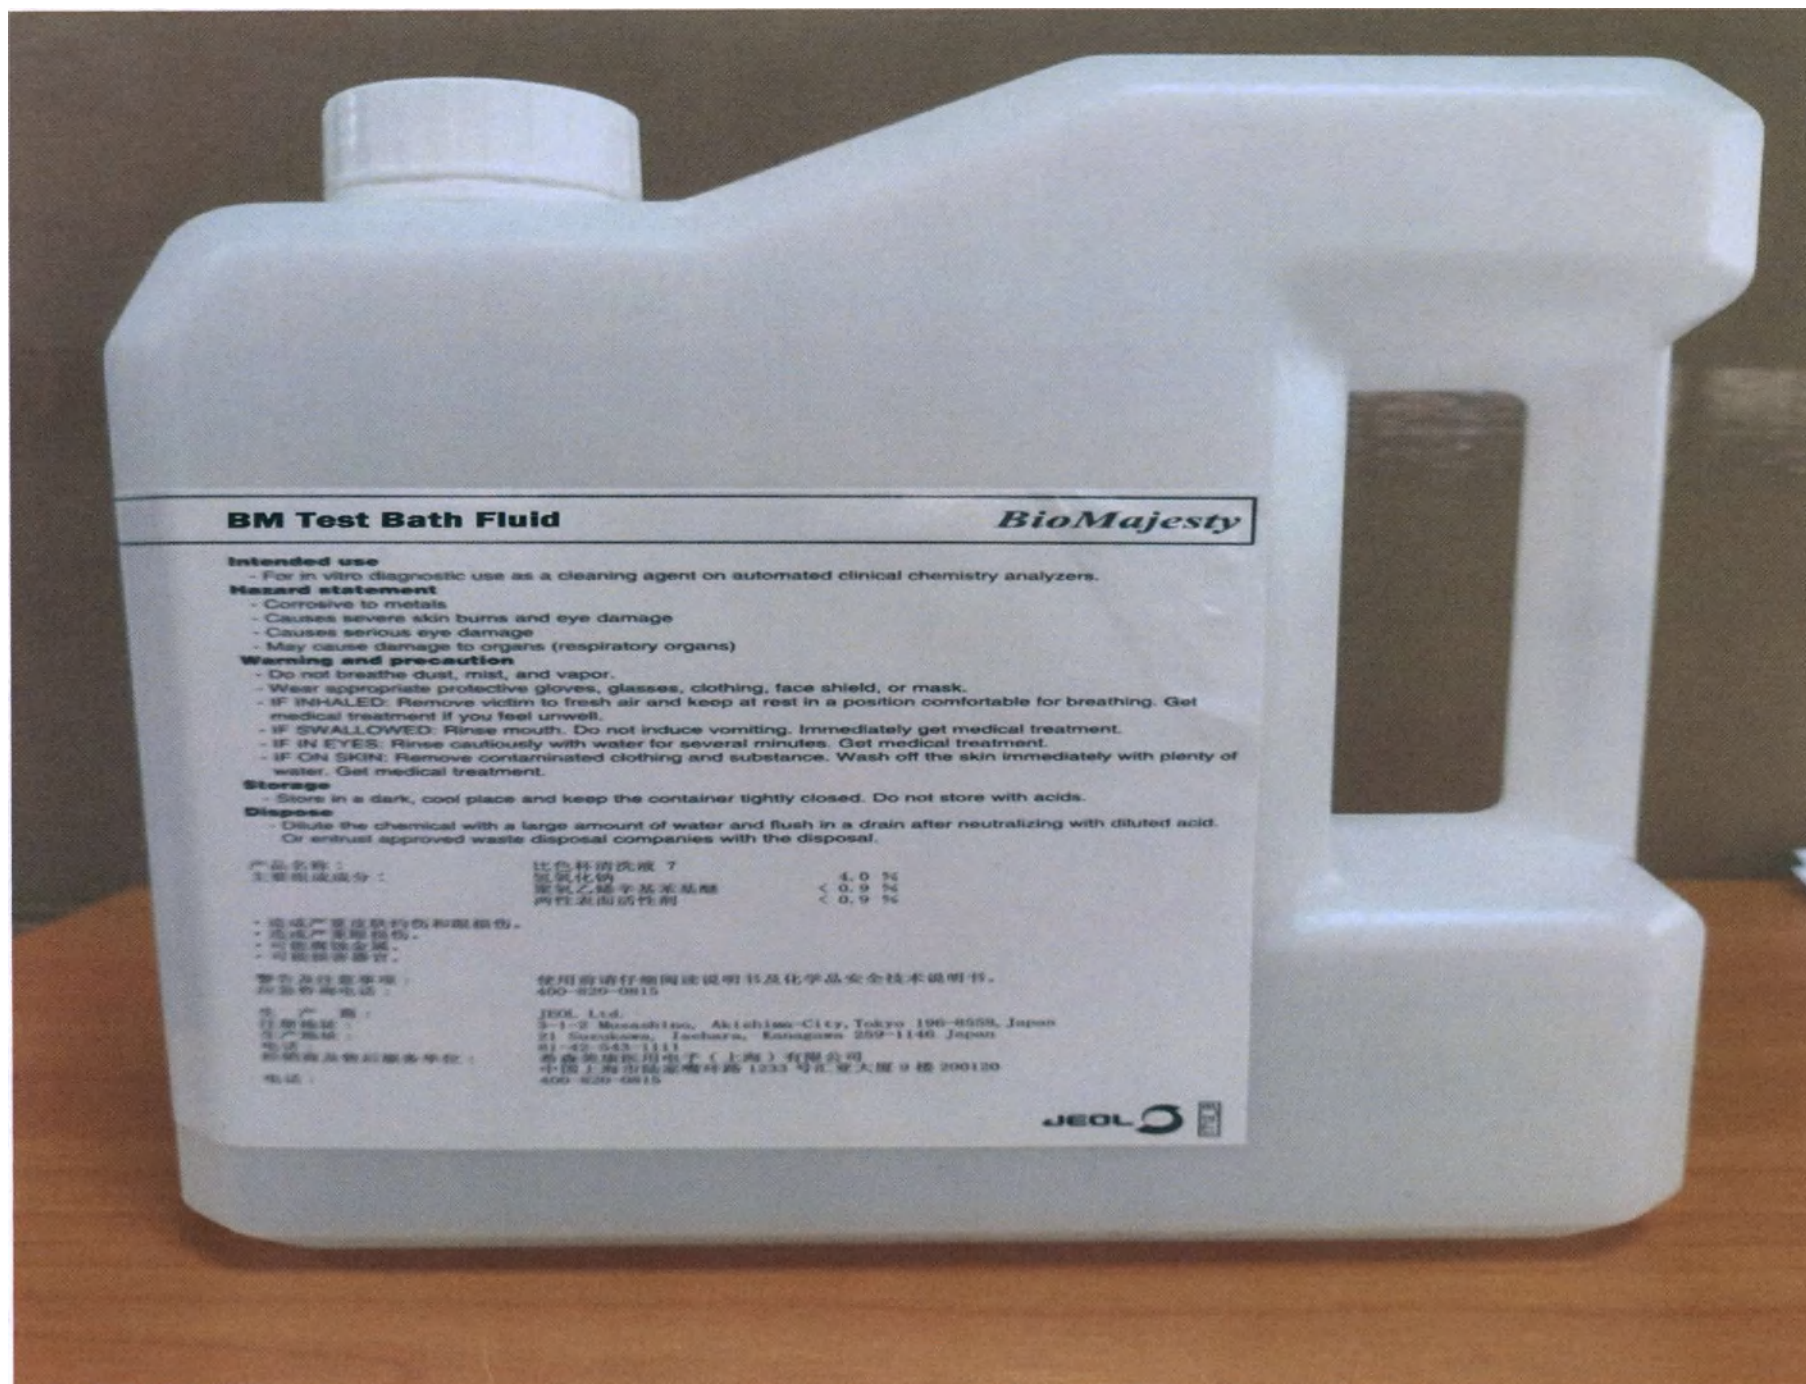


Рисунок 104

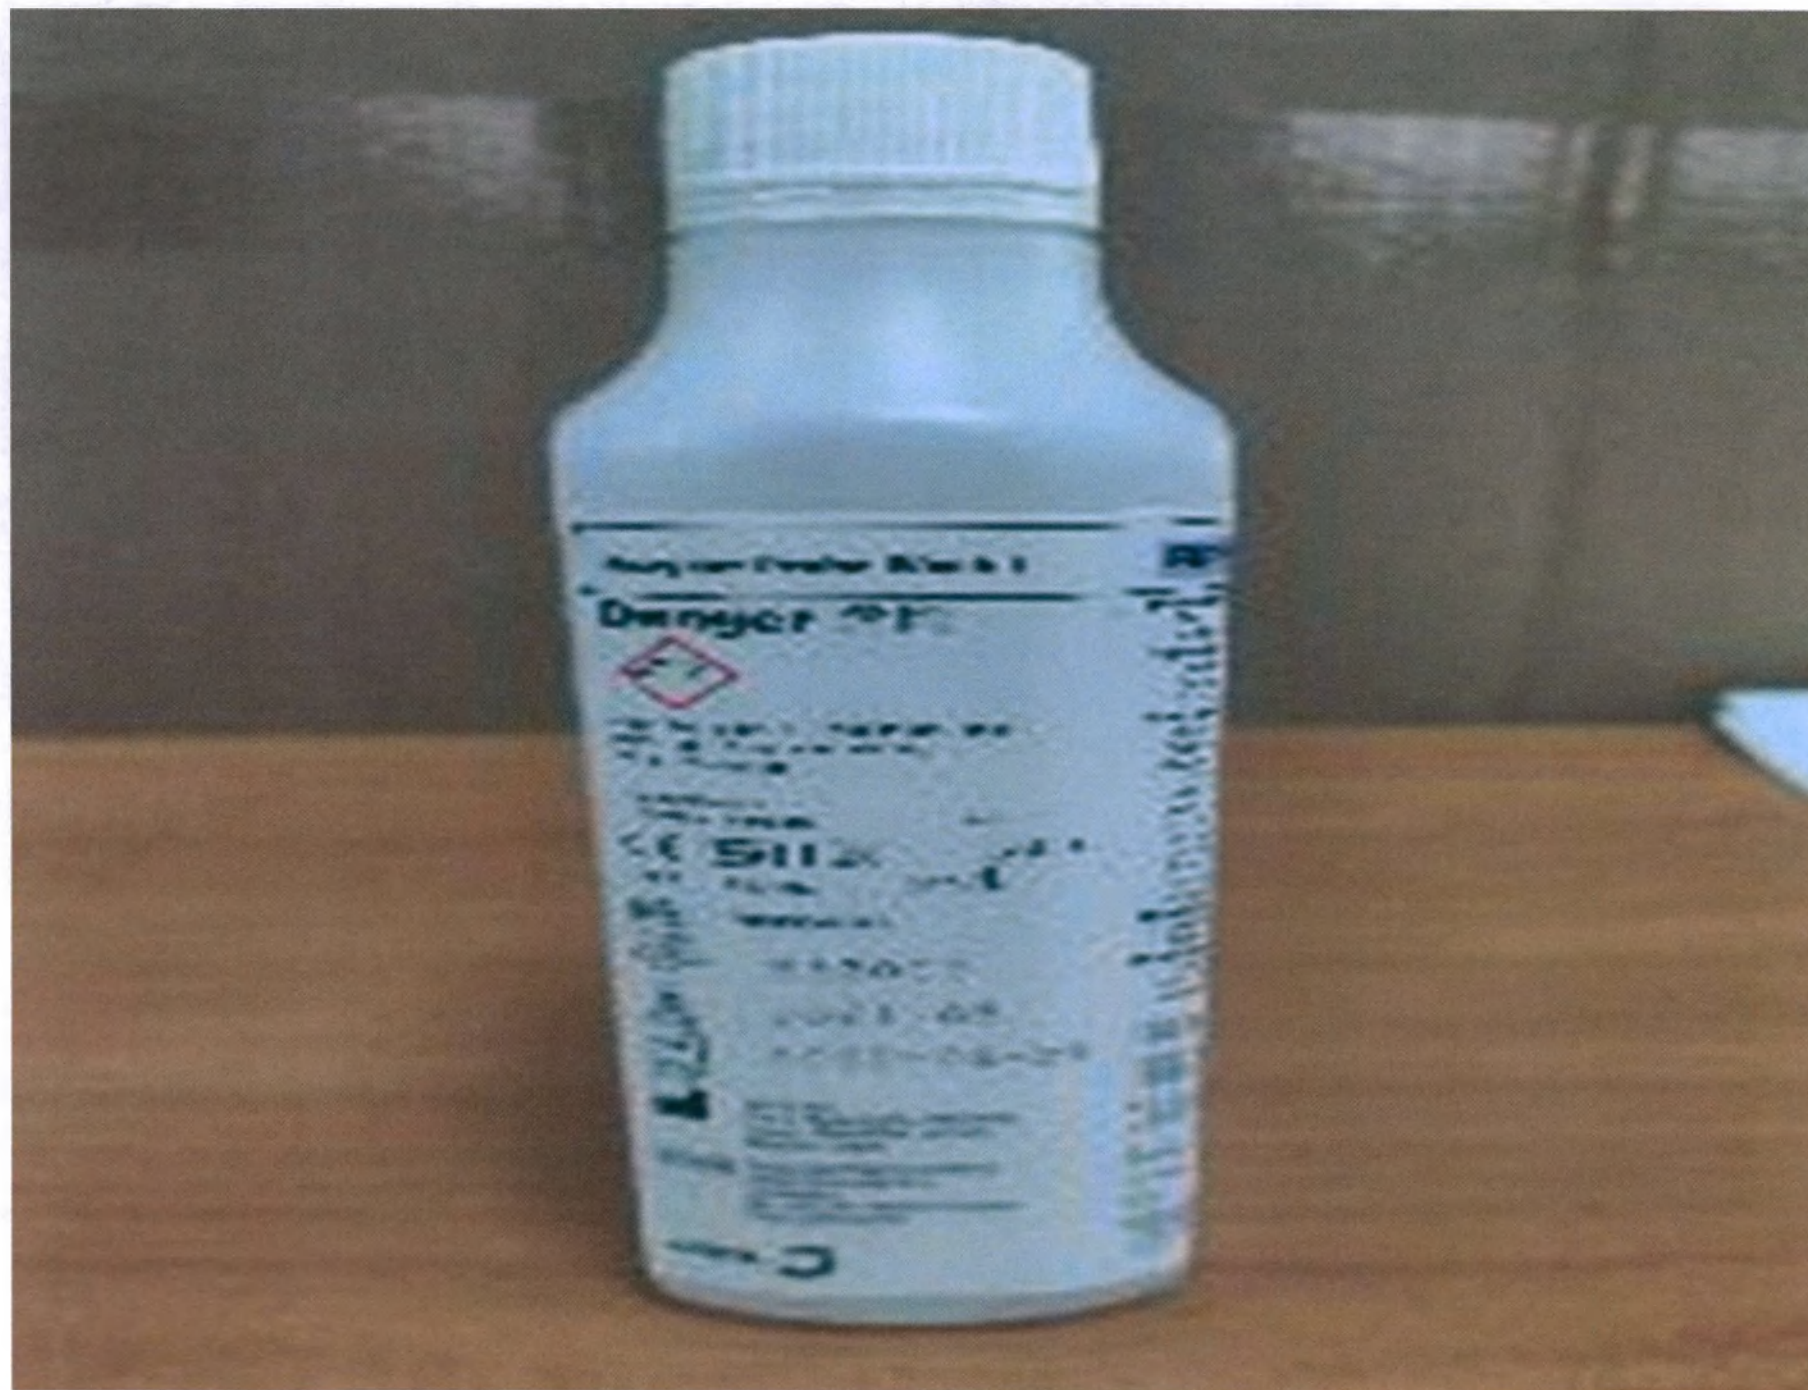


Рисунок 105



Рисунок 108

PARTS No. 480060096

JEOL

Desc.

PROBE (RPP)

Stand.

CM000484

Qty.

Expire Date

SerialNo./LotNo.

2.00ps

P.O

March, 04, 2020

REF No.

CA1906862/20

H

RoHS.

011

JAN

4 987762 124600

Made in JAPAN

GS1-128



(01)04987762124600

PARTS No. 780656415

Desc.

MIXER PADDLE

Stand.

490031706

Qty.

Expire Date

SerialNo./LotNo.

1.00pc

P.O

March, 04, 2020

REF No.

CA1906862/21

H

RoHS.

002

JAN

Made in JAPAN

GS1-128

4 987762 100512

(01)04987762100512

JEOL



Рисунок 110



Рисунок 111



Рисунок 112



Рисунок 113



Рисунок 114



Рисунок 115



Рисунок 116



Рисунок 117

INSTRUCTIONS

CA-21761RA102
RACK HANDLER 100

ICA-21761RA102-1 (E)

Printed in Japan



JEOL Ltd.
3-1-2 Musashino, Akishim
Tokyo 196-8558, JAPAN

JEOL (Germany) GmbH
Gute Aenger 30
85356 Freising, Germany






Рисунок 119



Рисунок 120

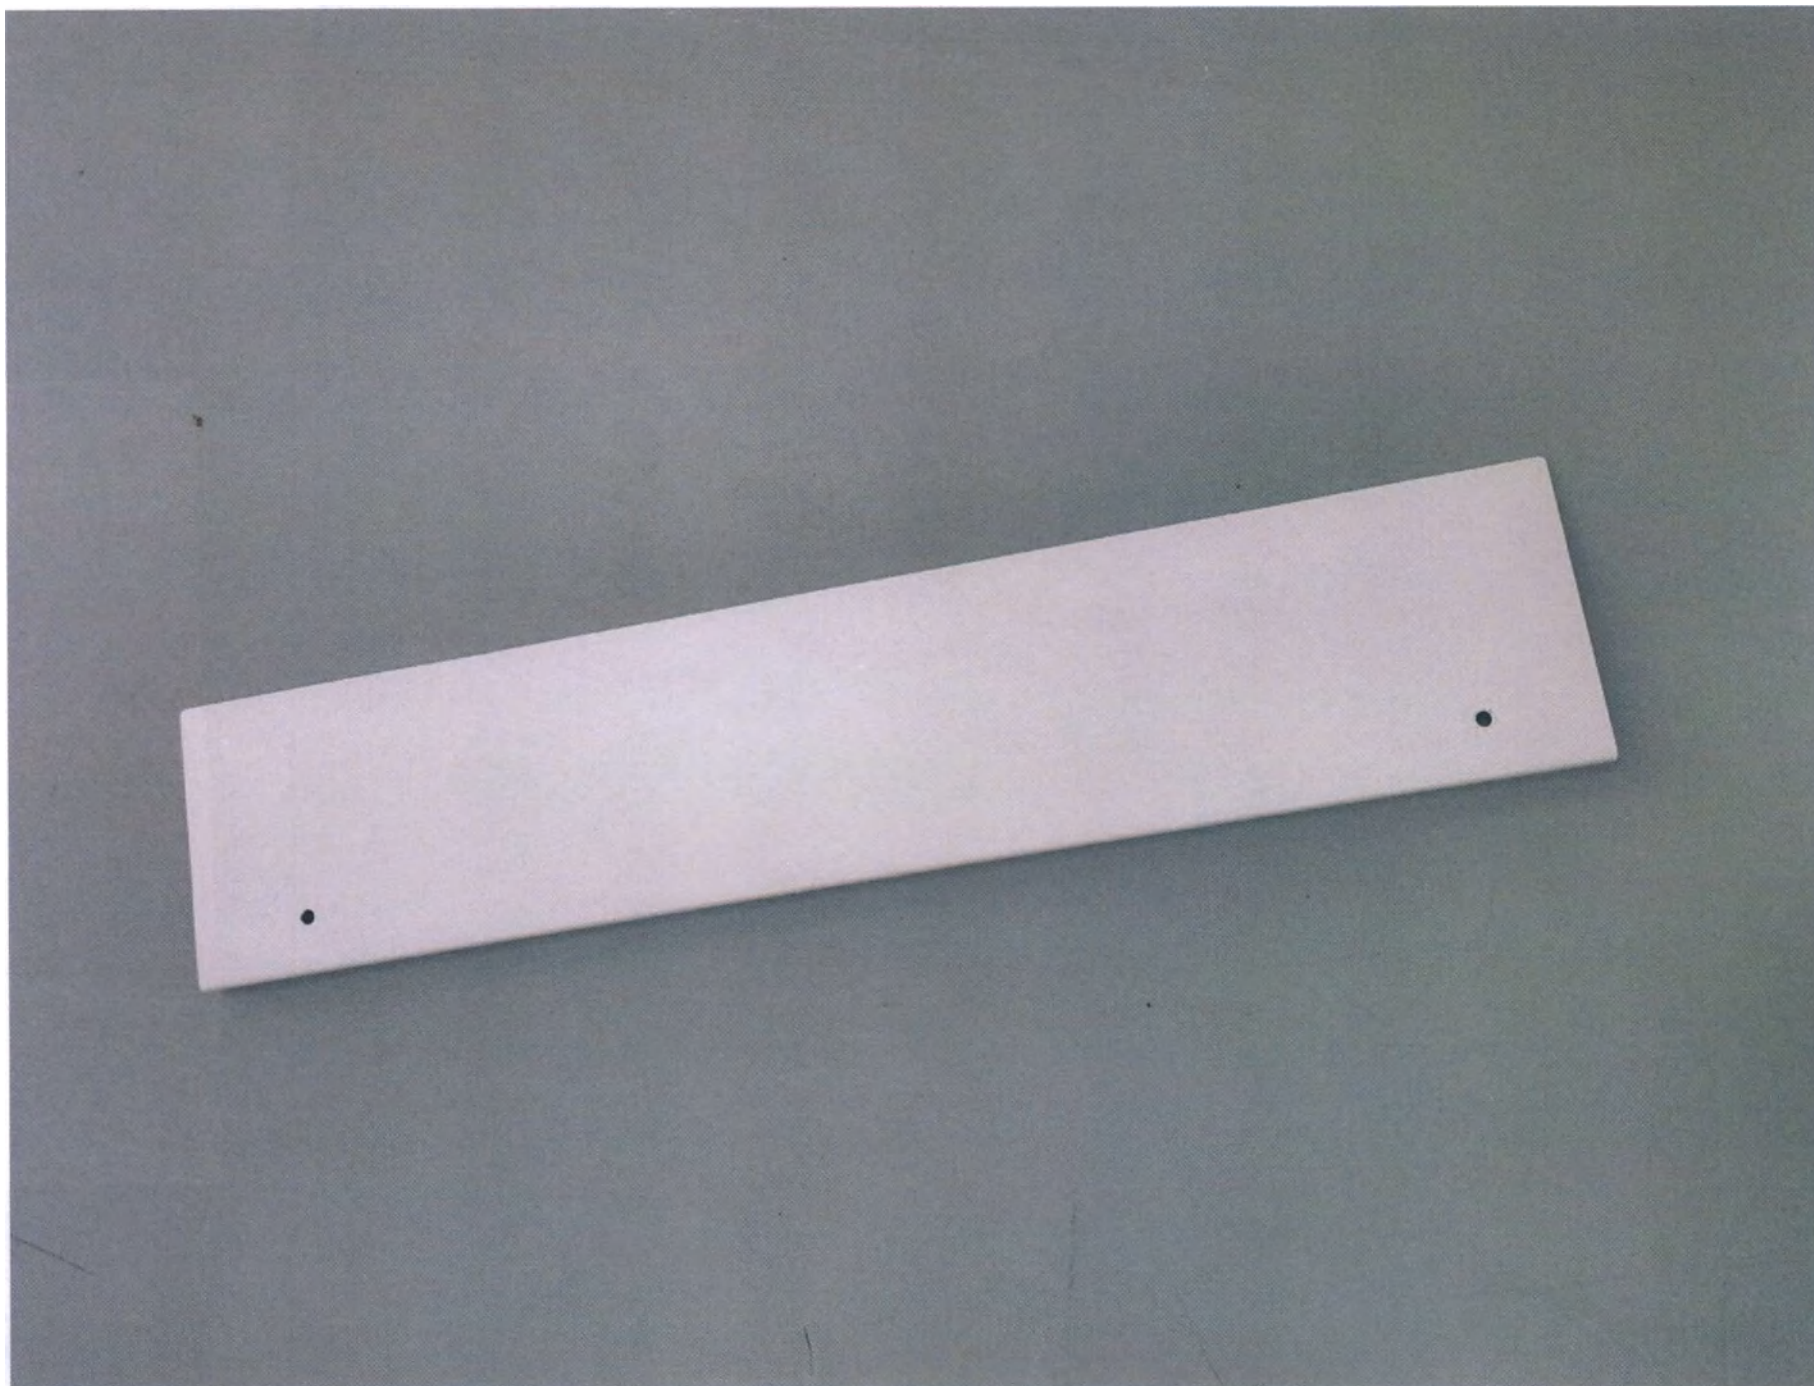


Рисунок 121

В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью

133 (Сто тридцать три) листов.

Генеральный директор
АО «ДИАКОН»

Иванов А.В.

