

Генеральный директор
ООО «ЮМТЕКС»



Д. Ю. Захарченко

«13» февраля 2023 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия

Аппарат лазерный медицинский RevLite SI

Рисунок 1. Рабочая станция RevLite SI



Рисунок 2. Шарнирный манипулятор

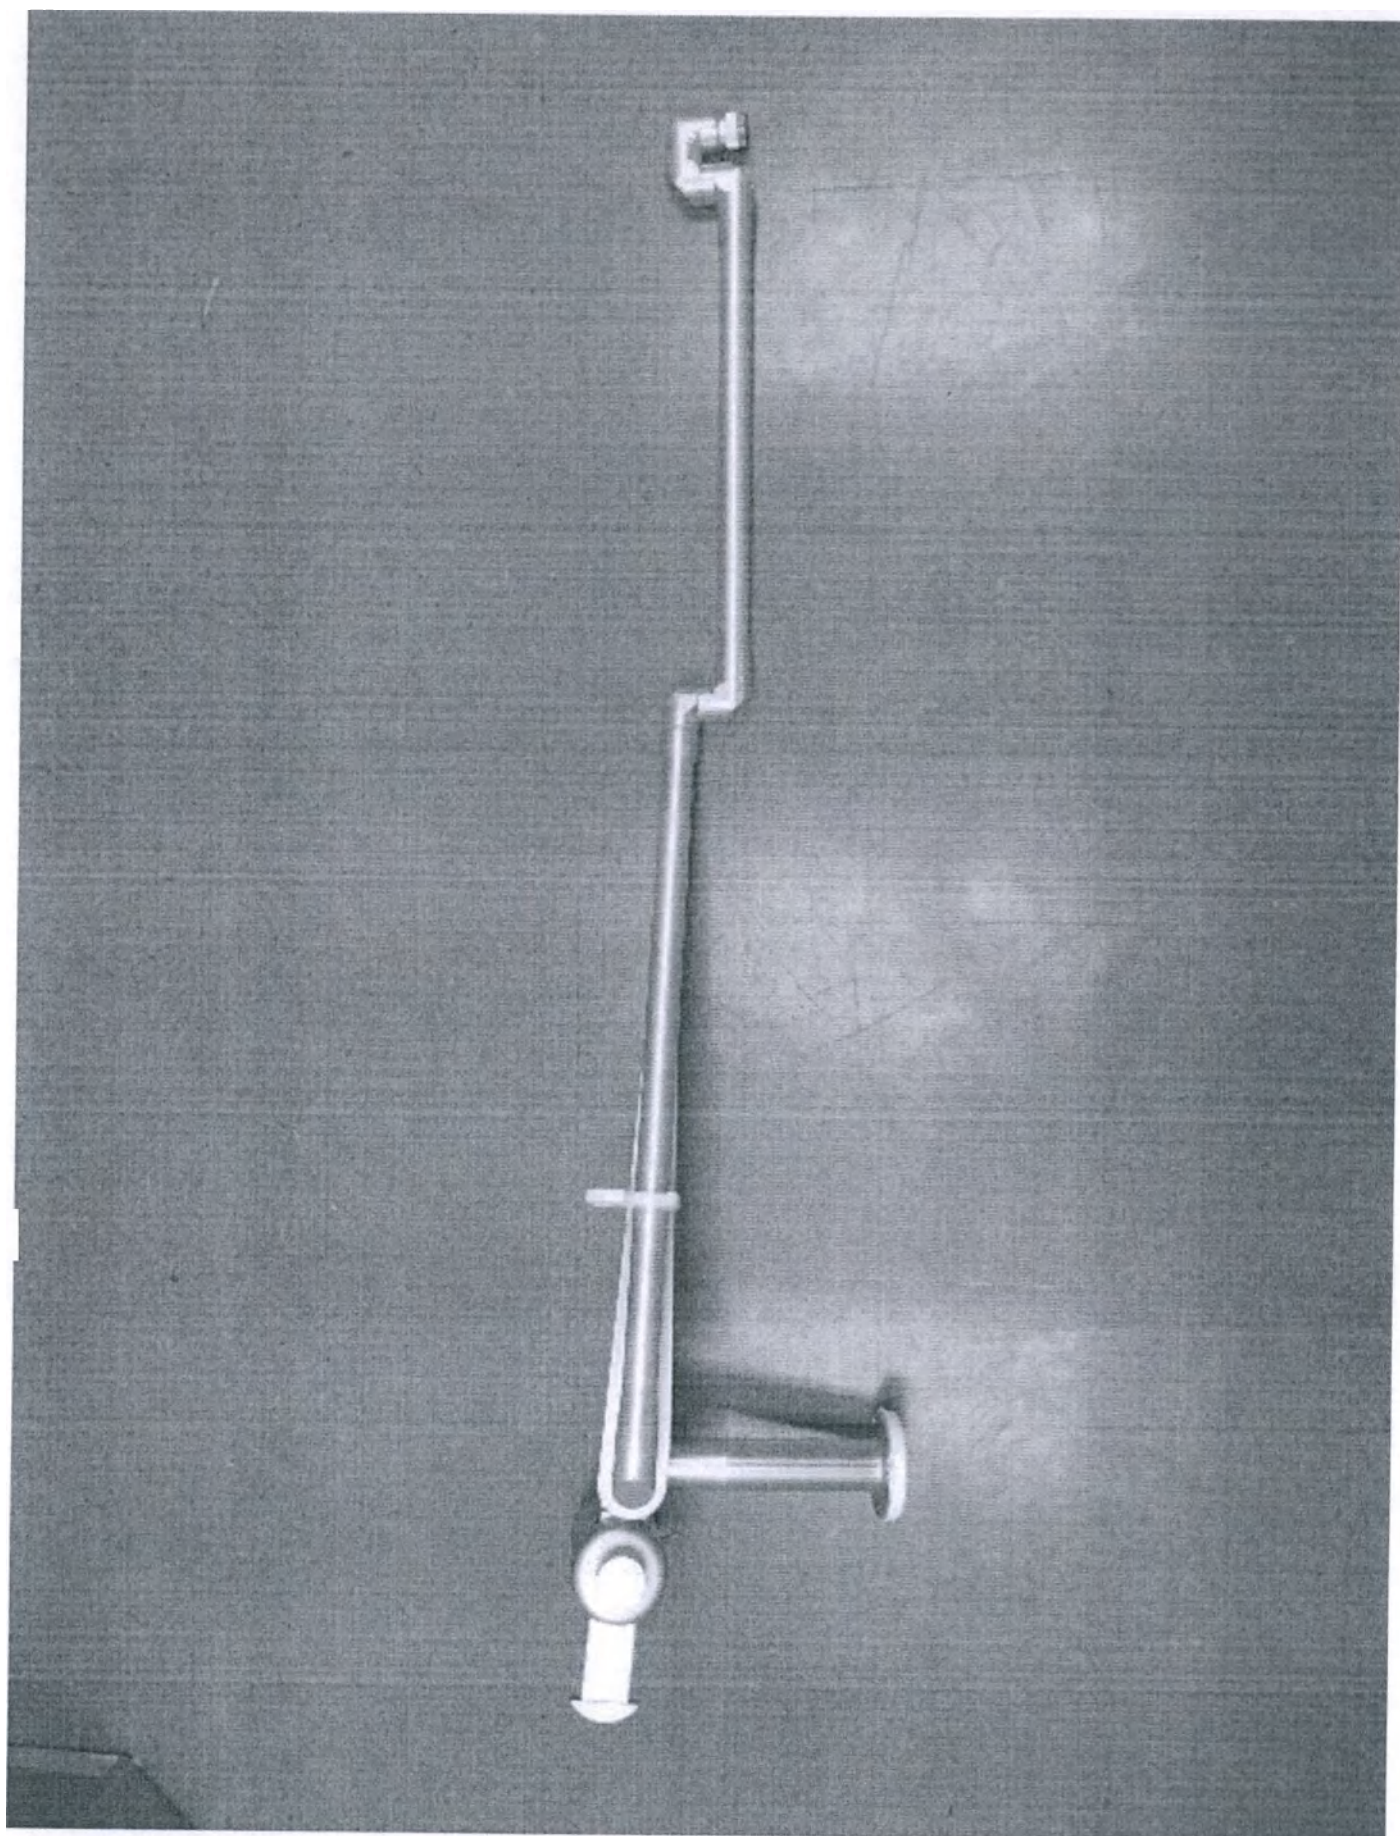


Рисунок 3. Манипула Smart Infinite (VariSpot)

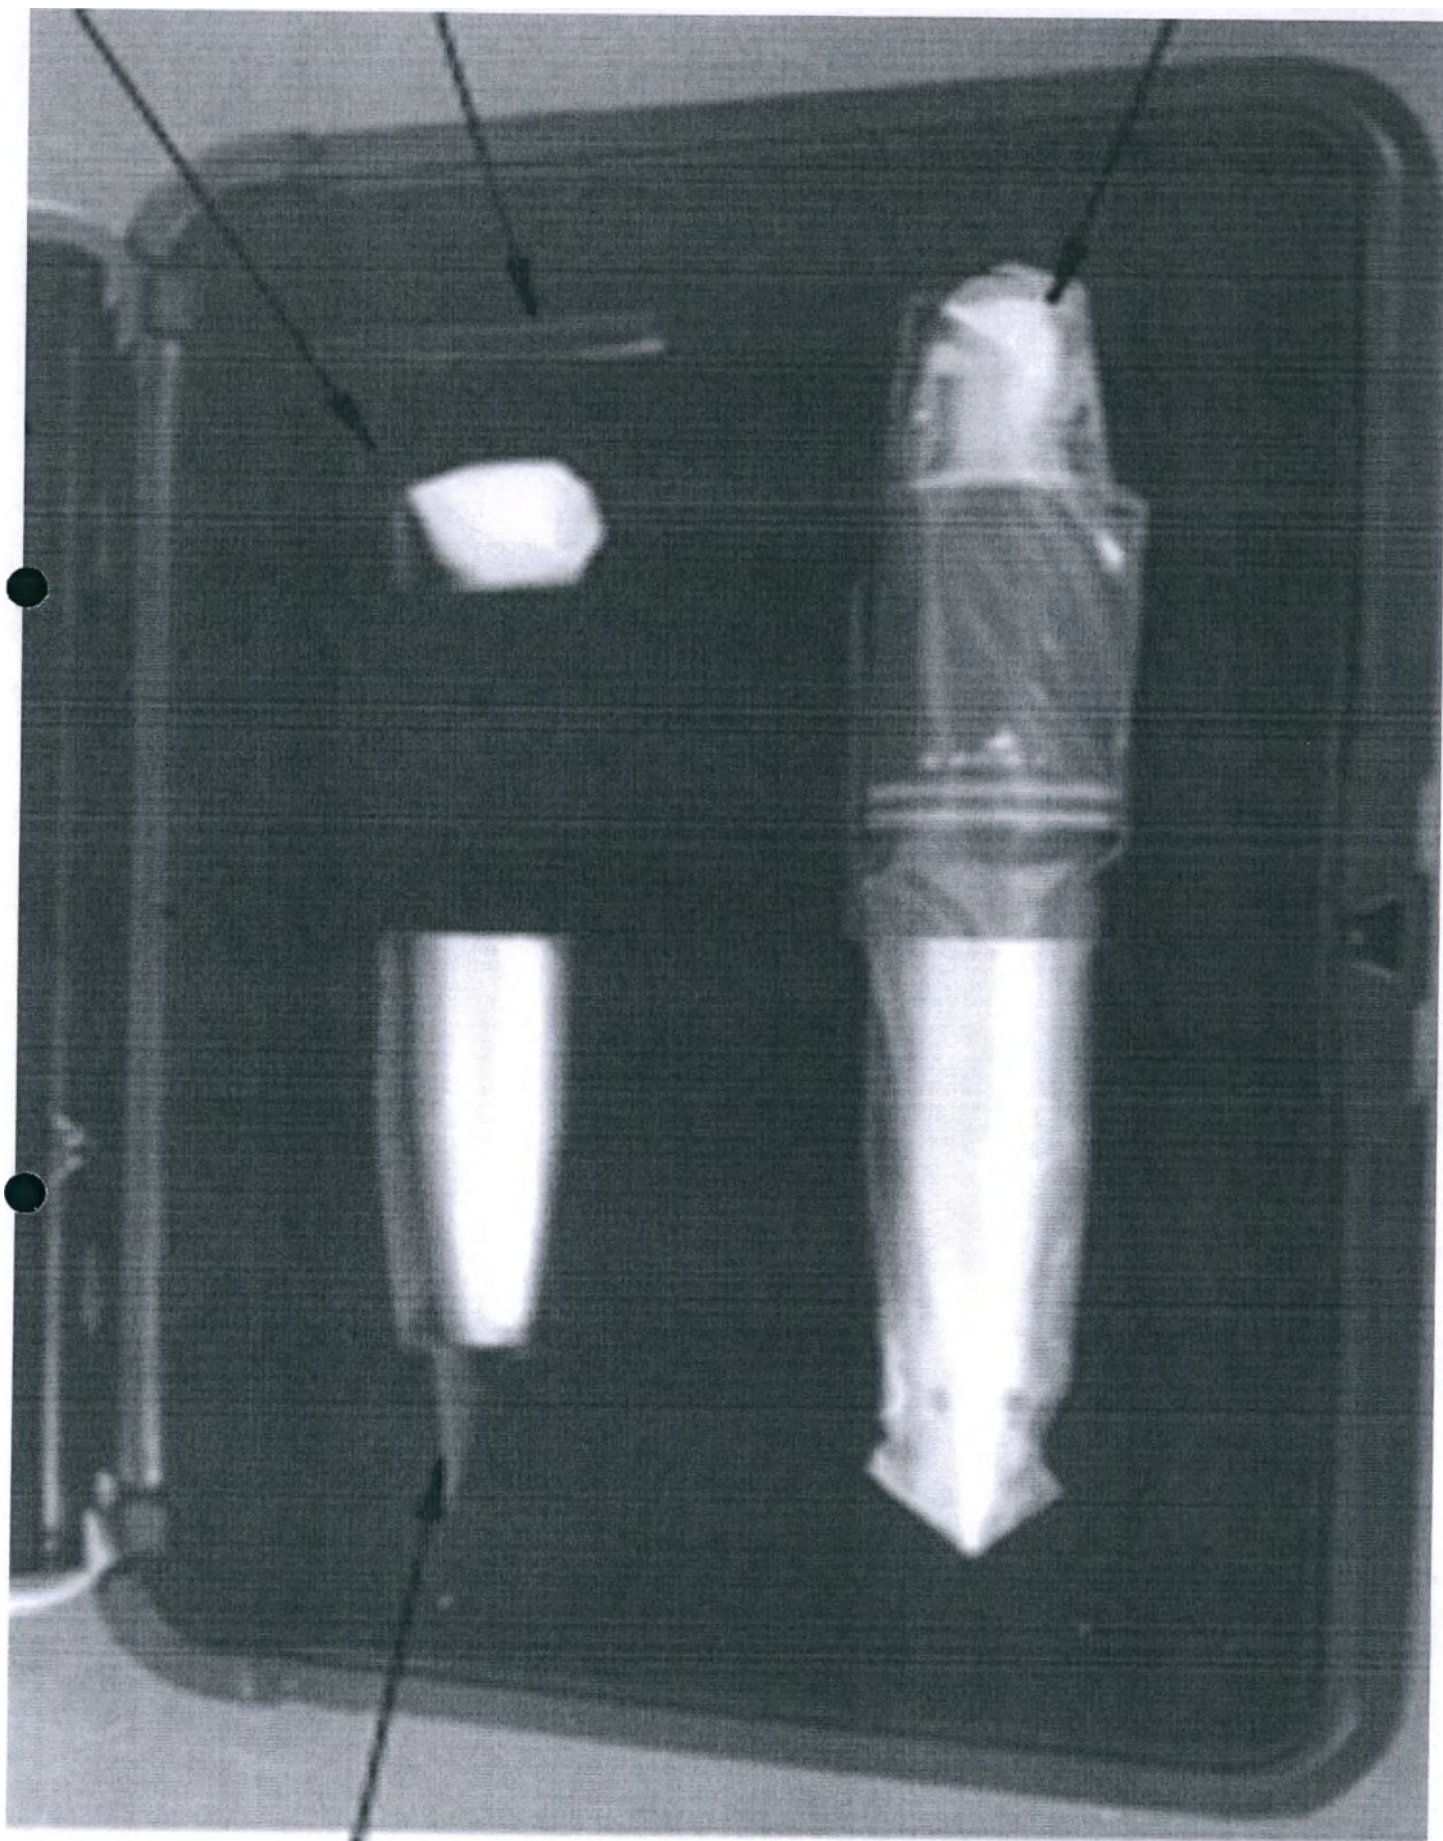


Рисунок 4. Корпус манипулы VariSpot

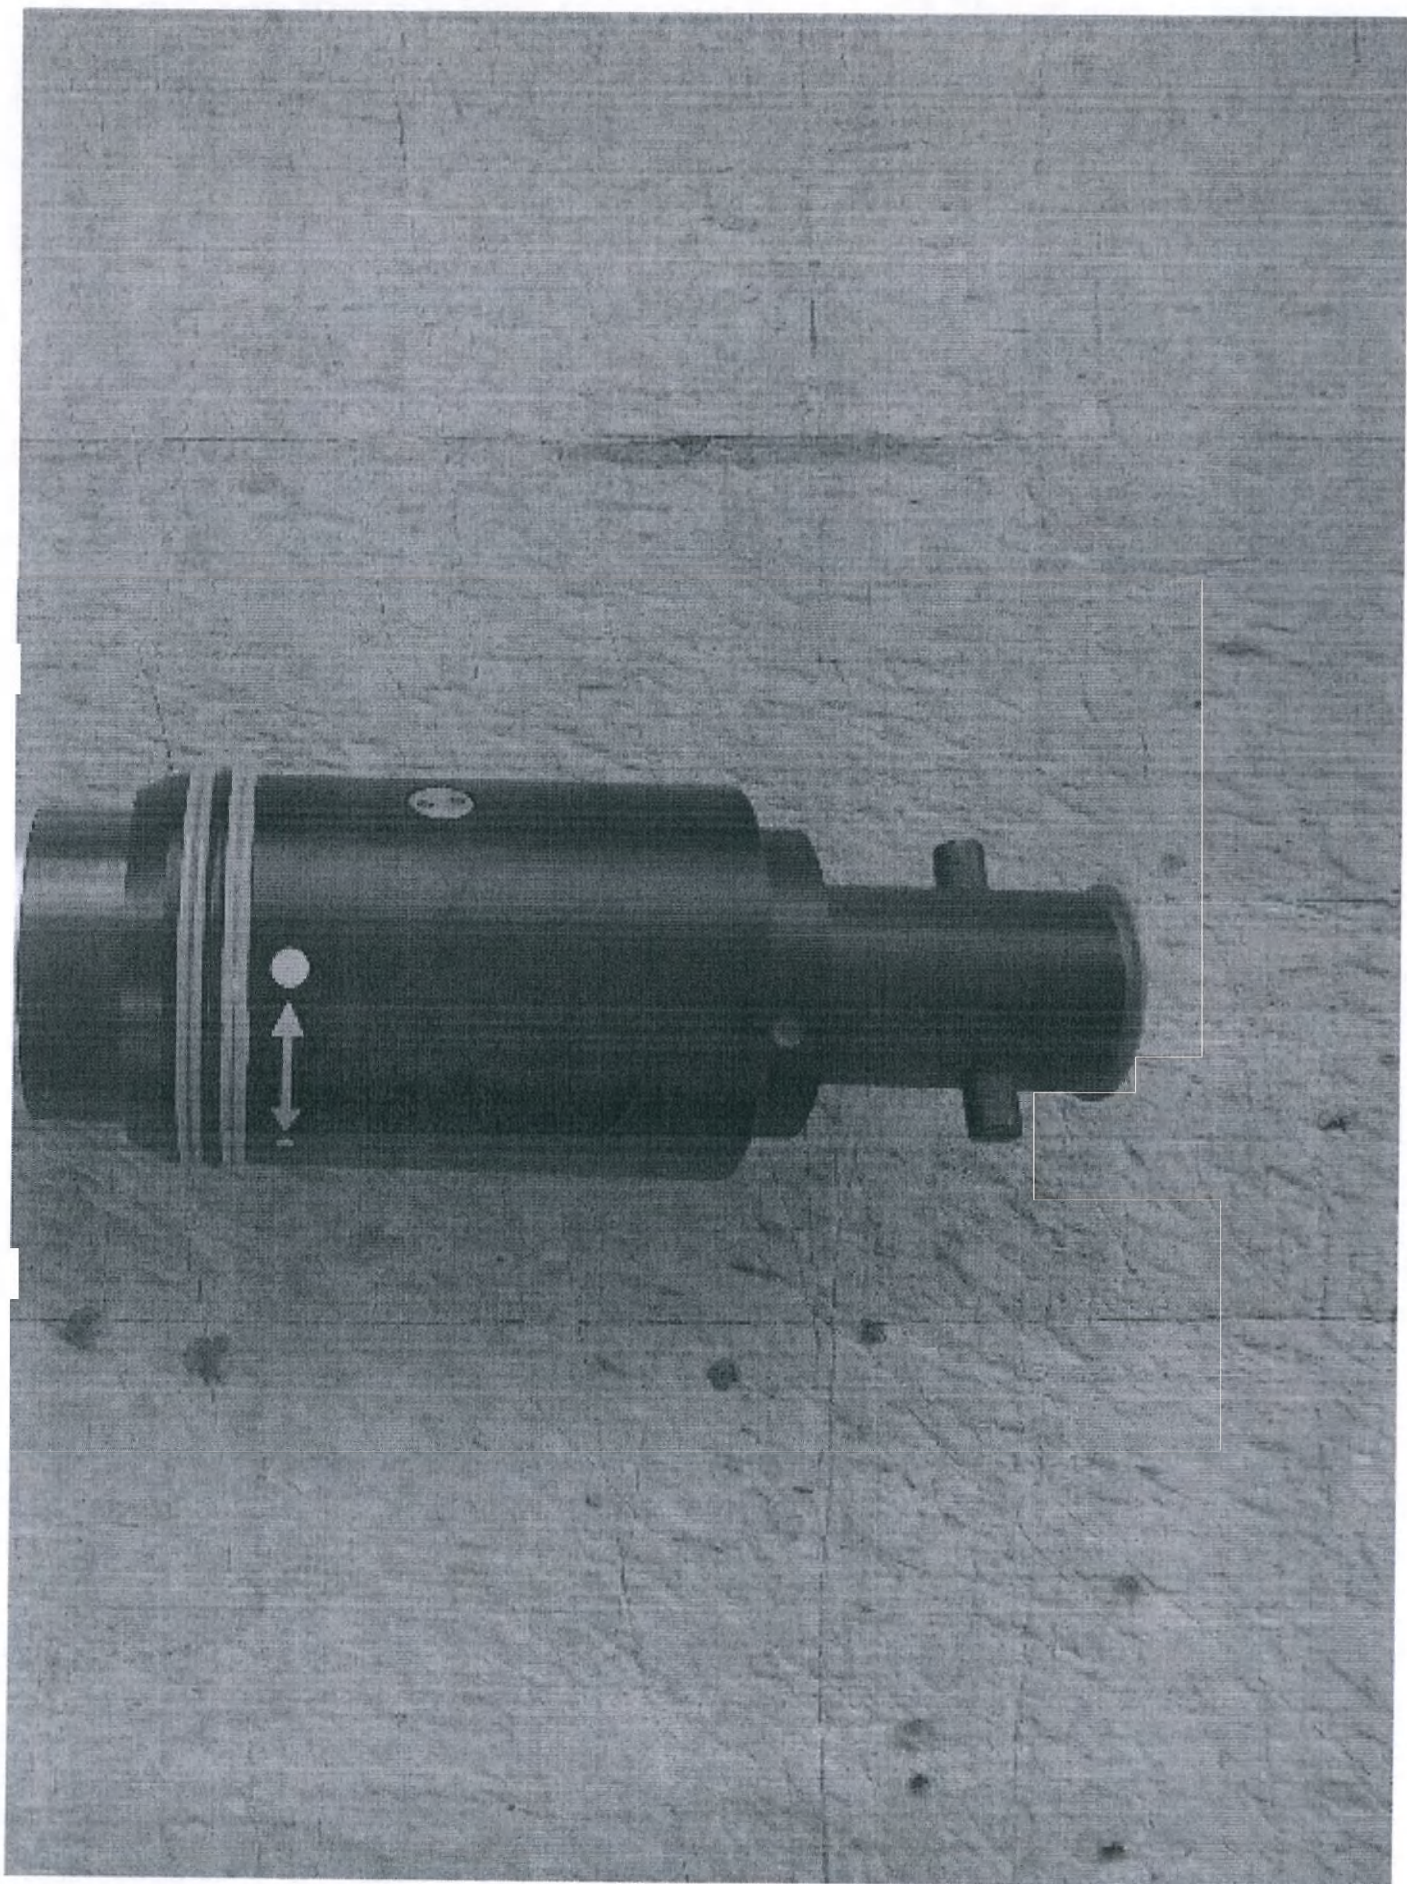


Рисунок 5. Наконечник манипулы VariSpot

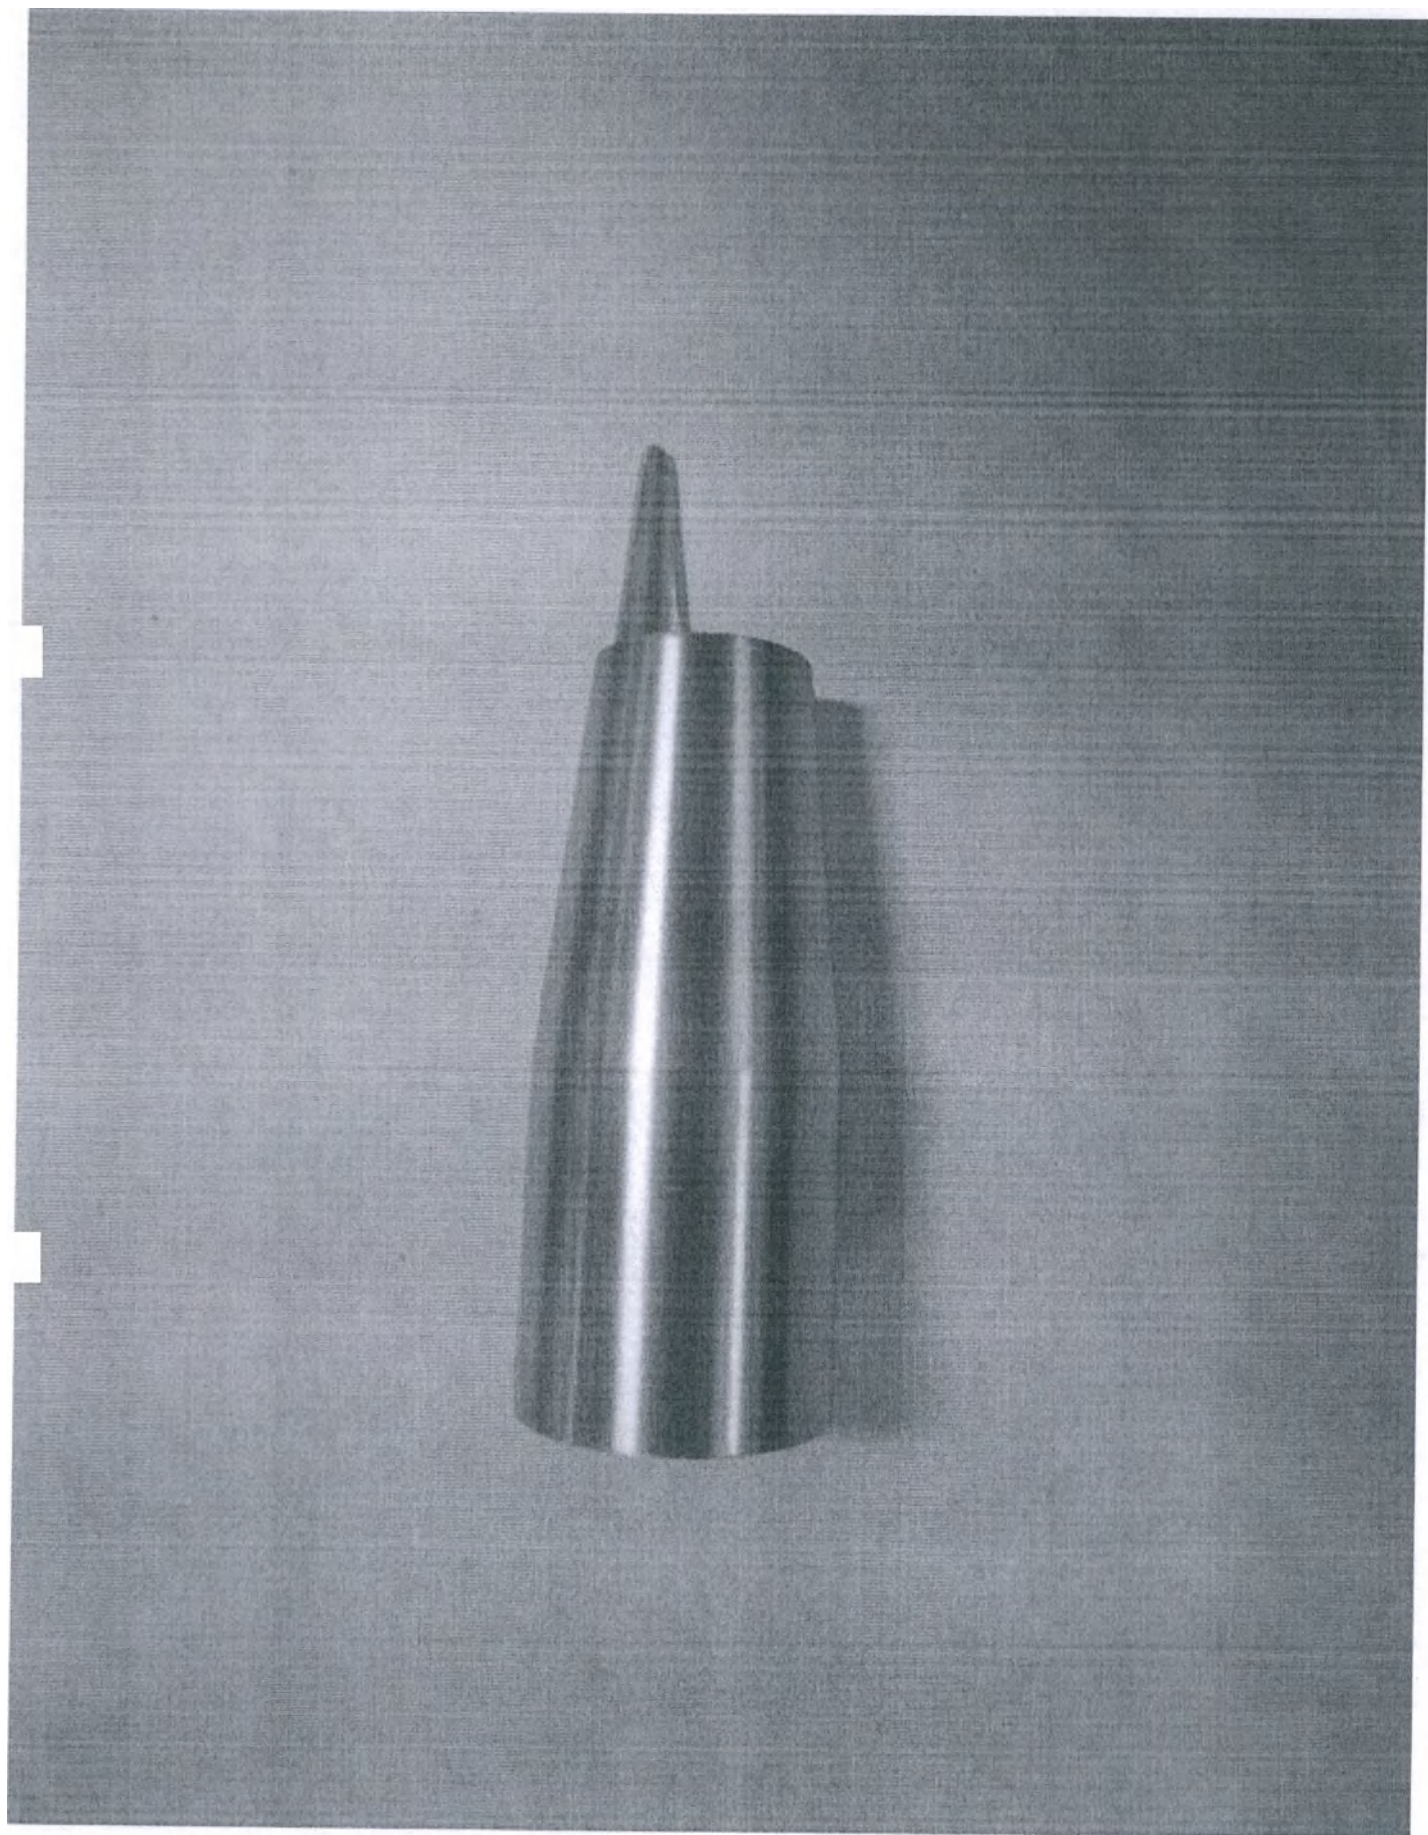


Рисунок 6. Защитное стекло манипулы VariSpot

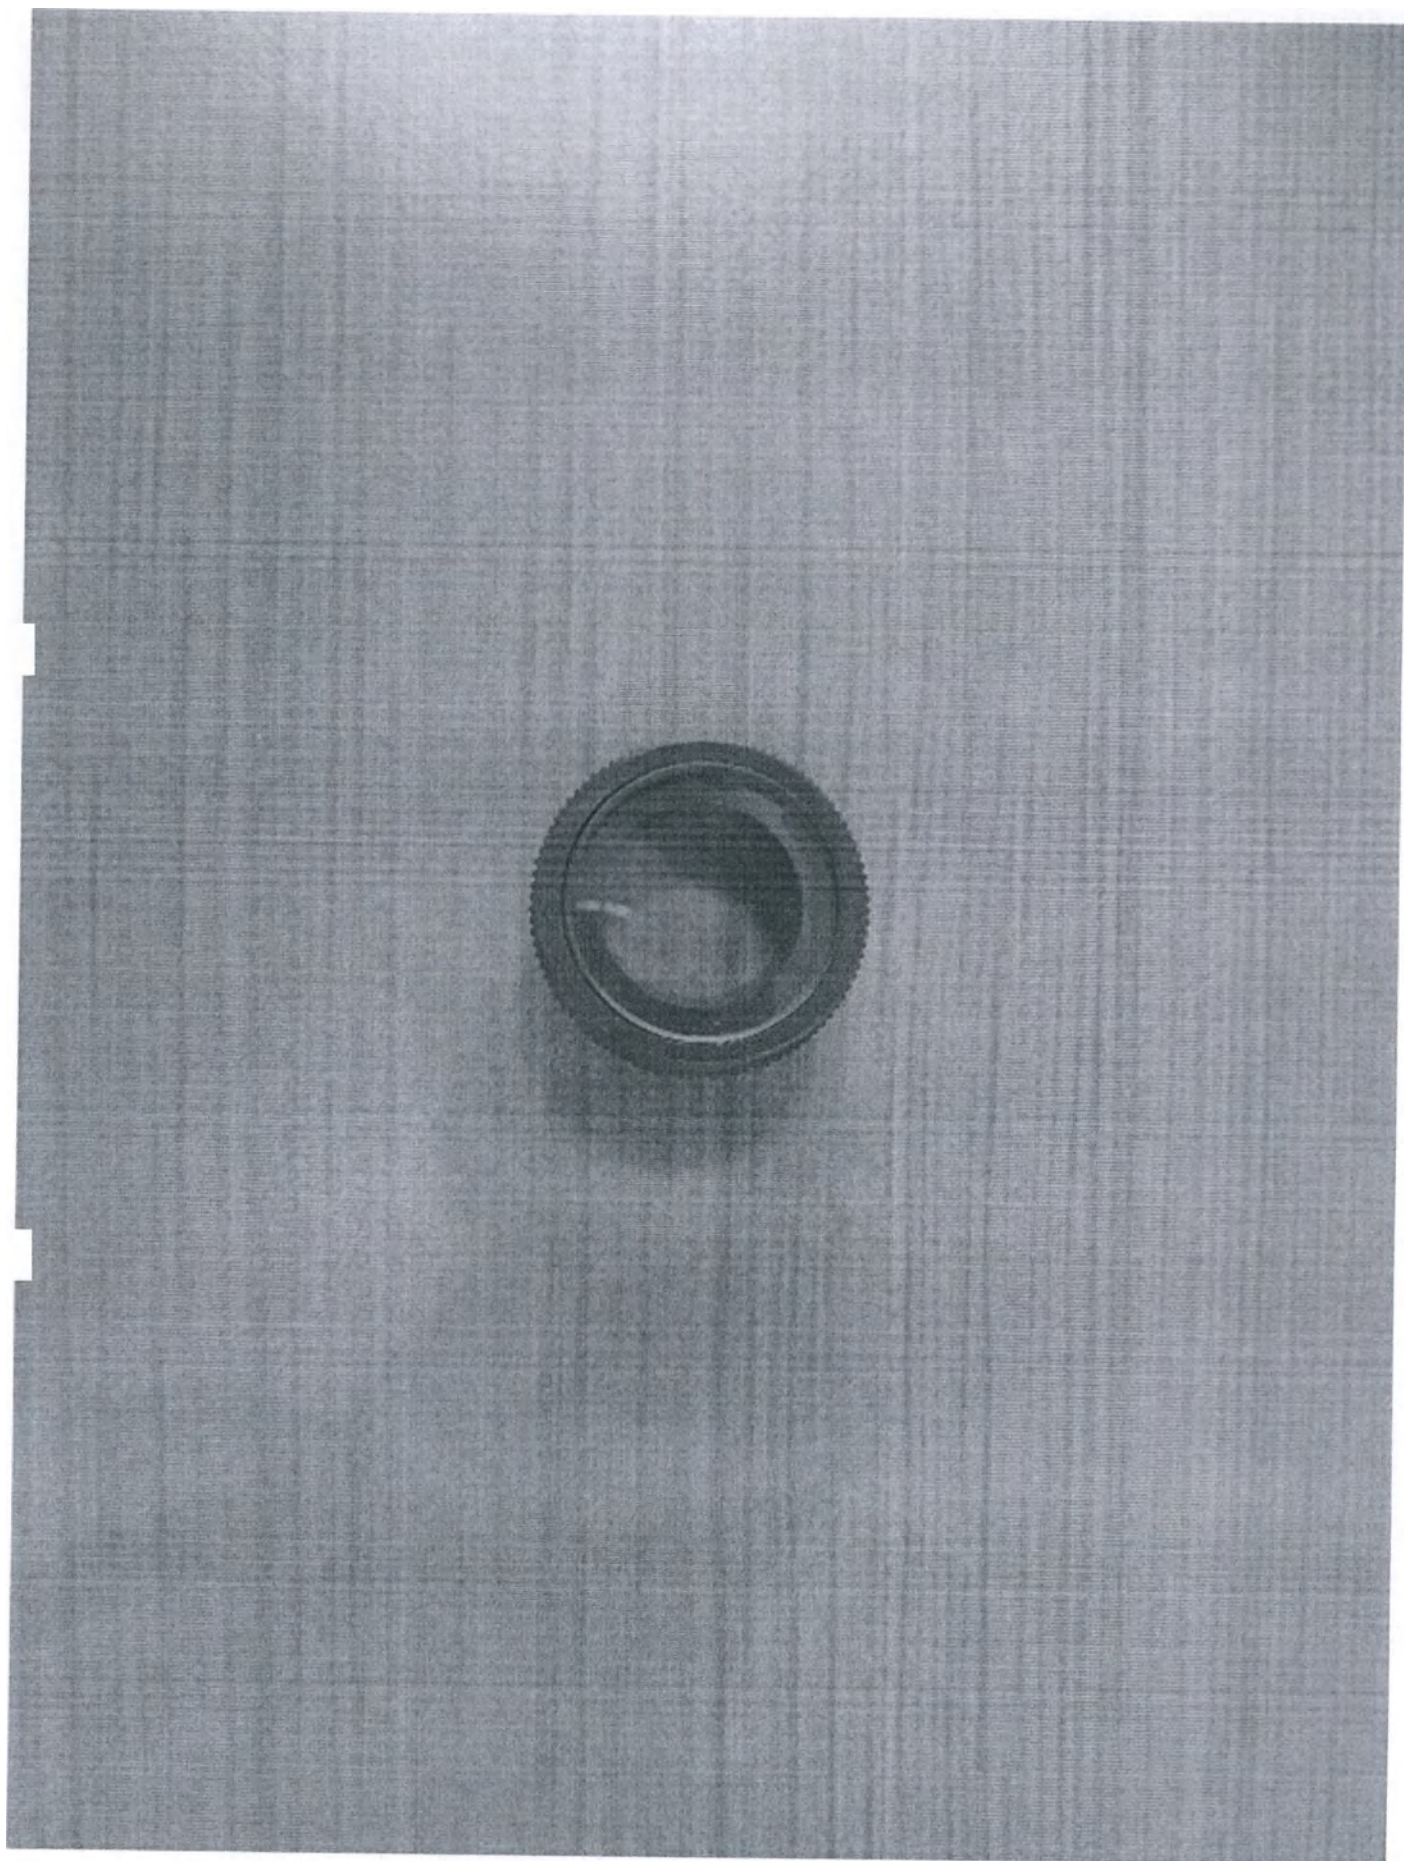
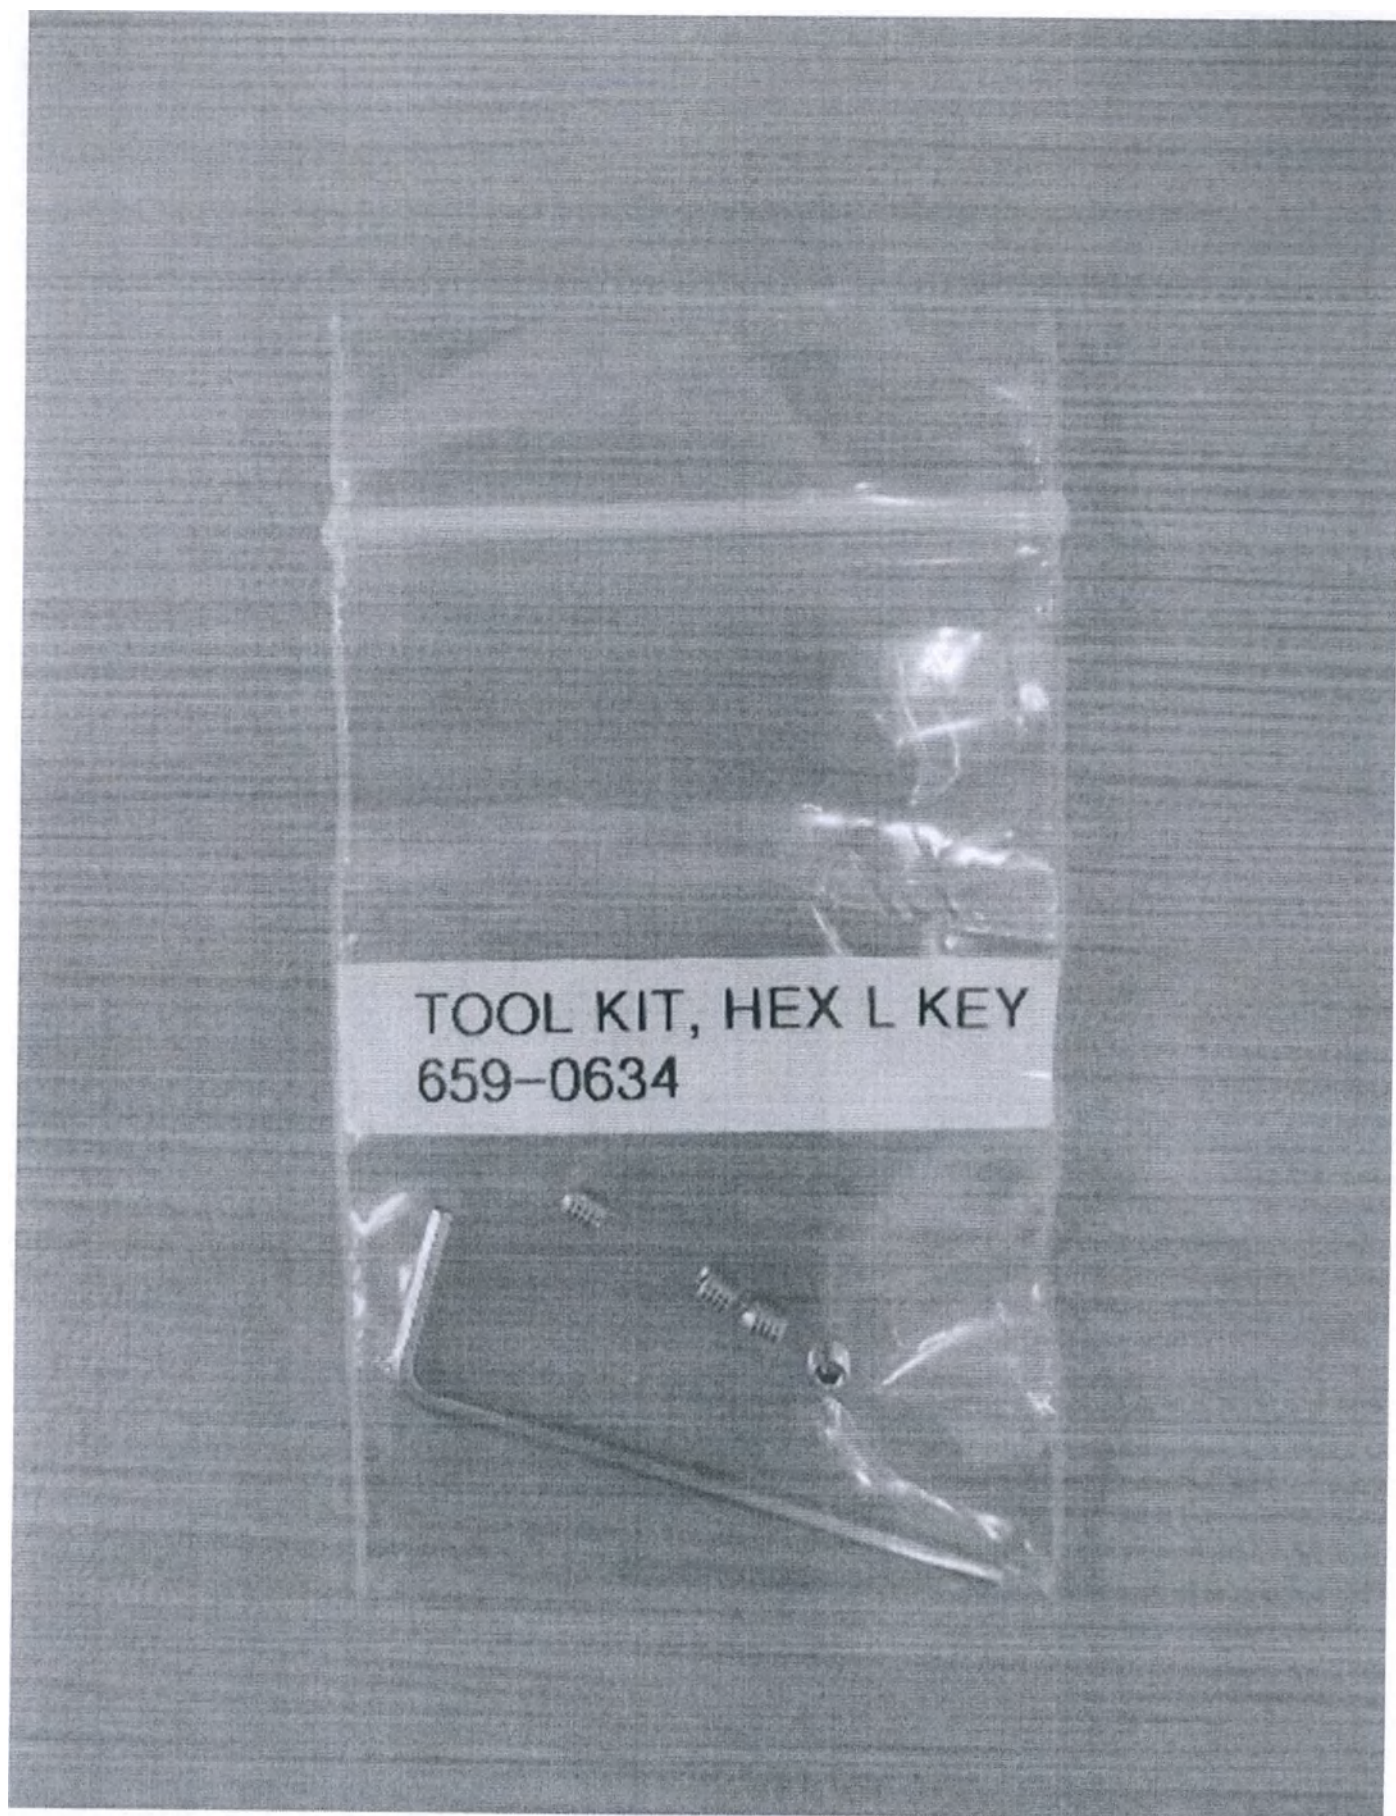


Рисунок 7. Комплект инструментов



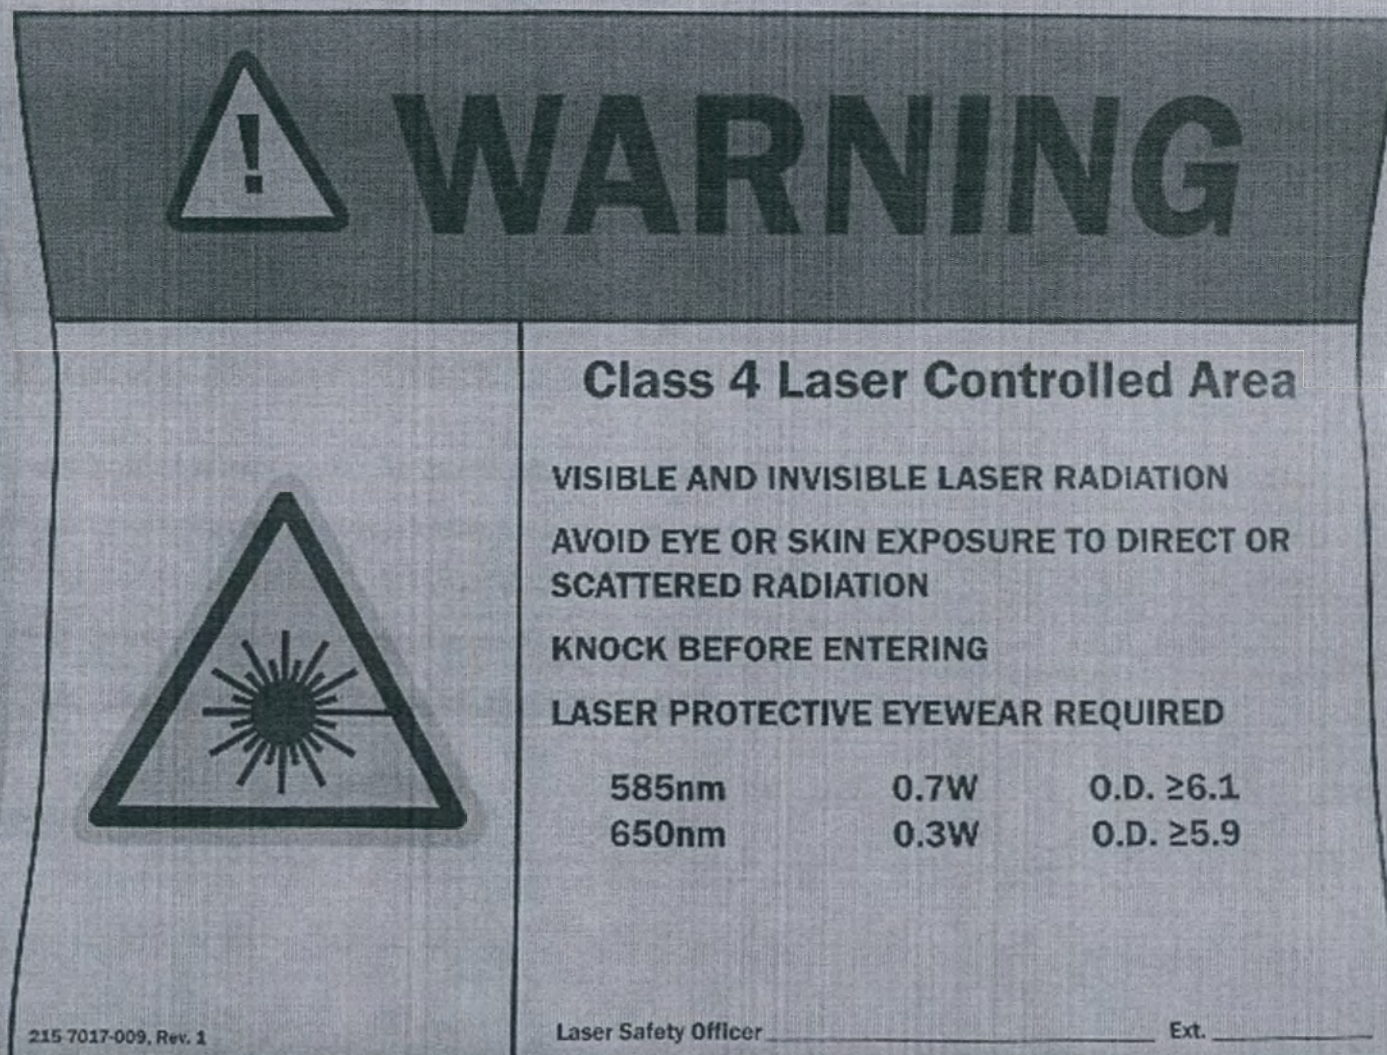


Рисунок 9. Манипула 532Lite SI (VariSpot)

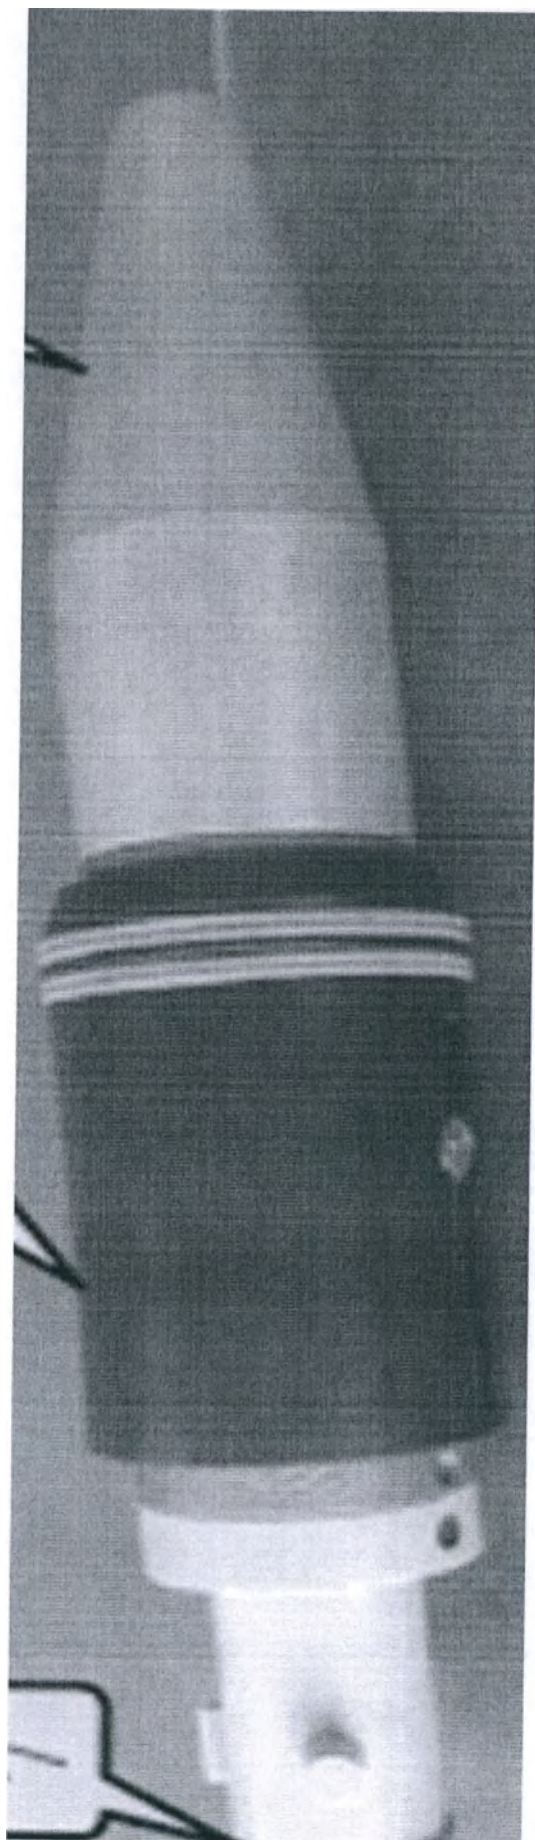


Рисунок 10. Корпус манипулы 532Lite SI (Varisport)



Рисунок 11. Наконечник манипулы 532Lite SI (Varisport)



Рисунок 12. Колпачок виниловый 532Lite SI (Varispot)

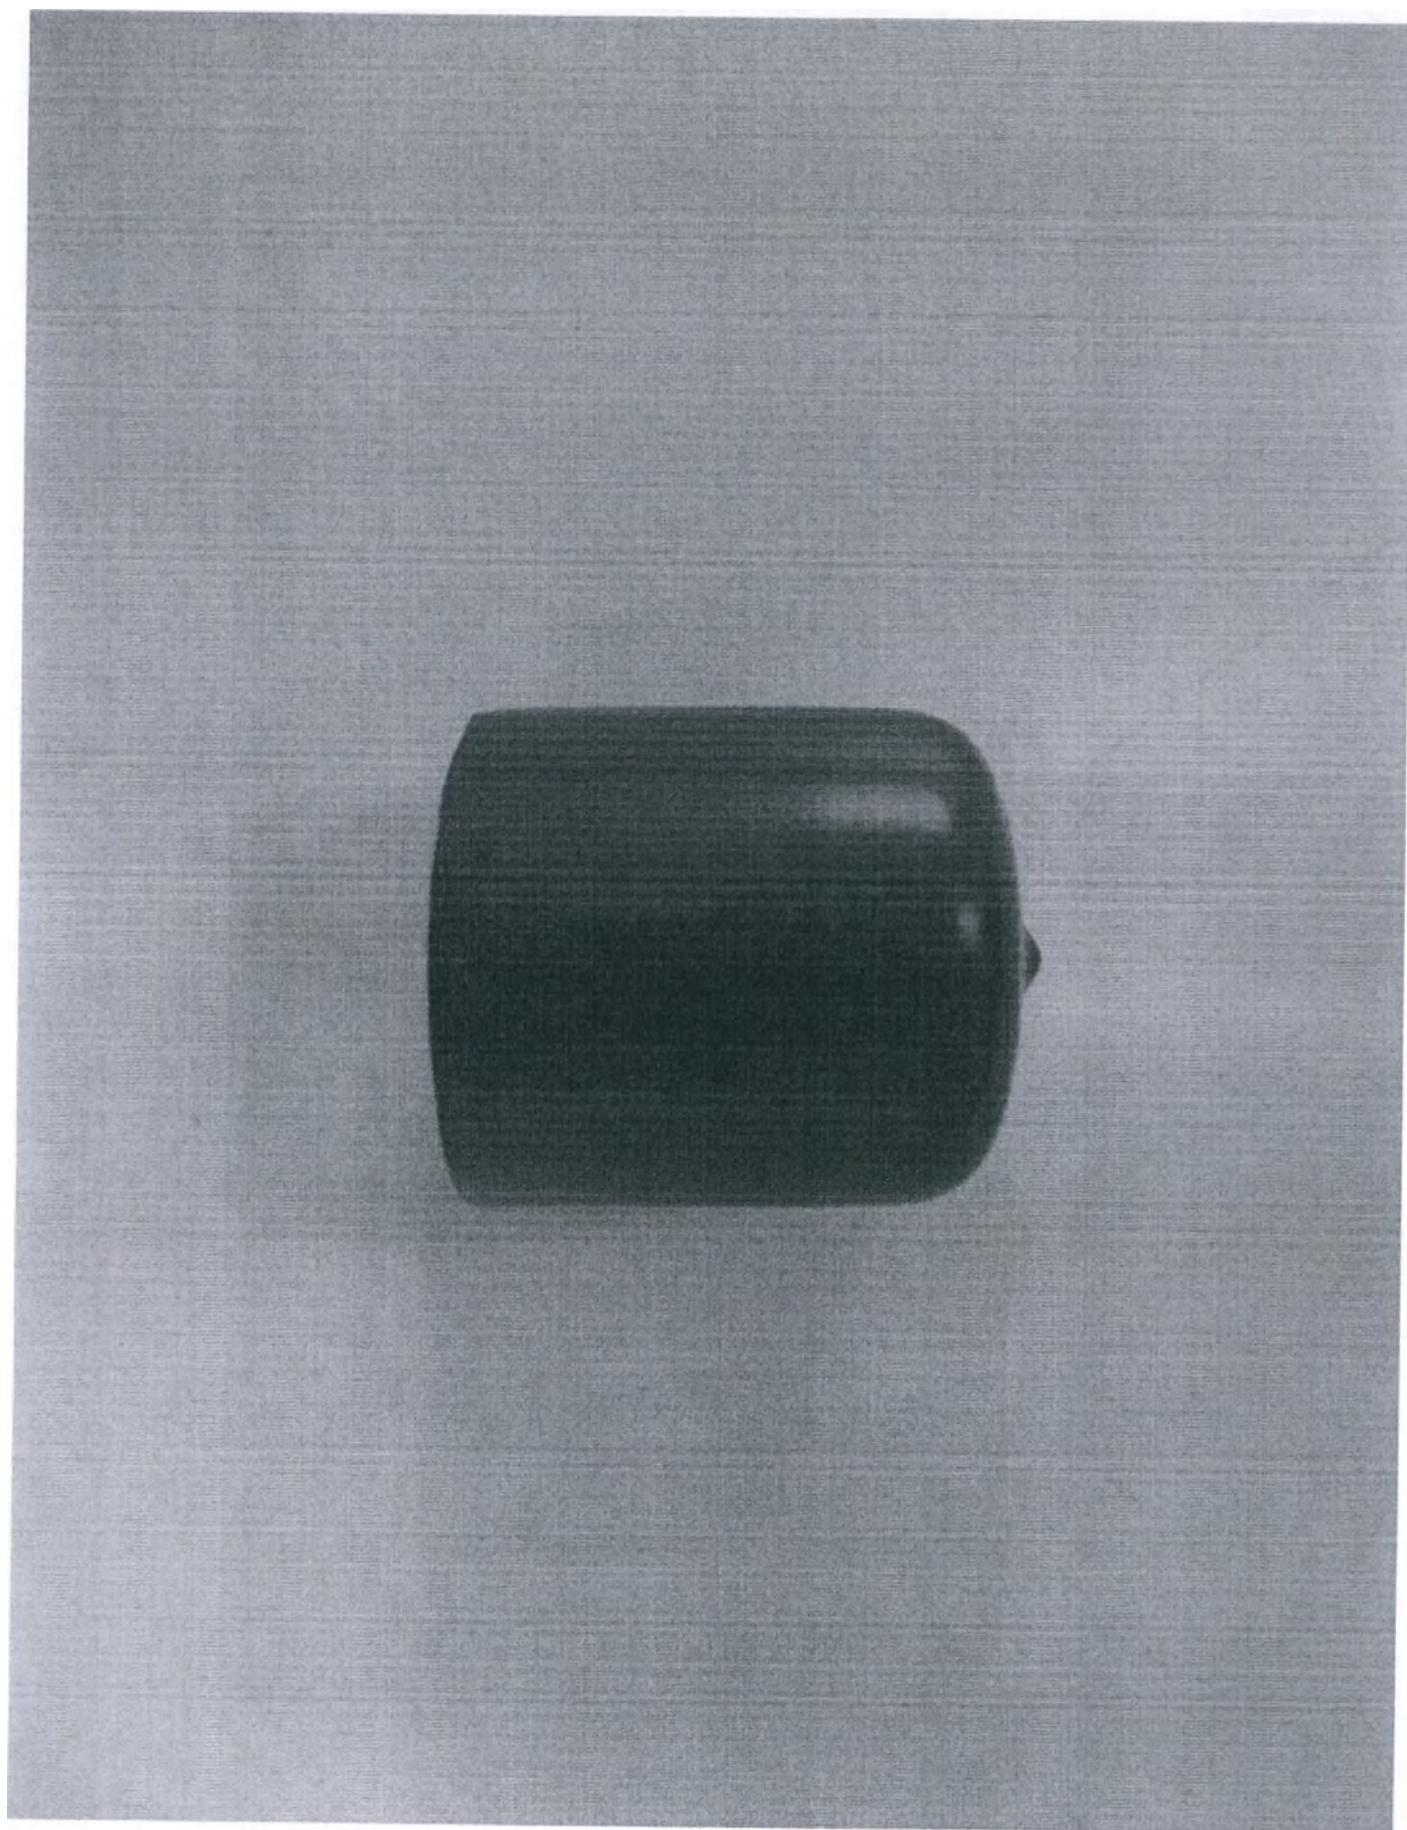


Рисунок 13. Заглушка полиэтиленовая

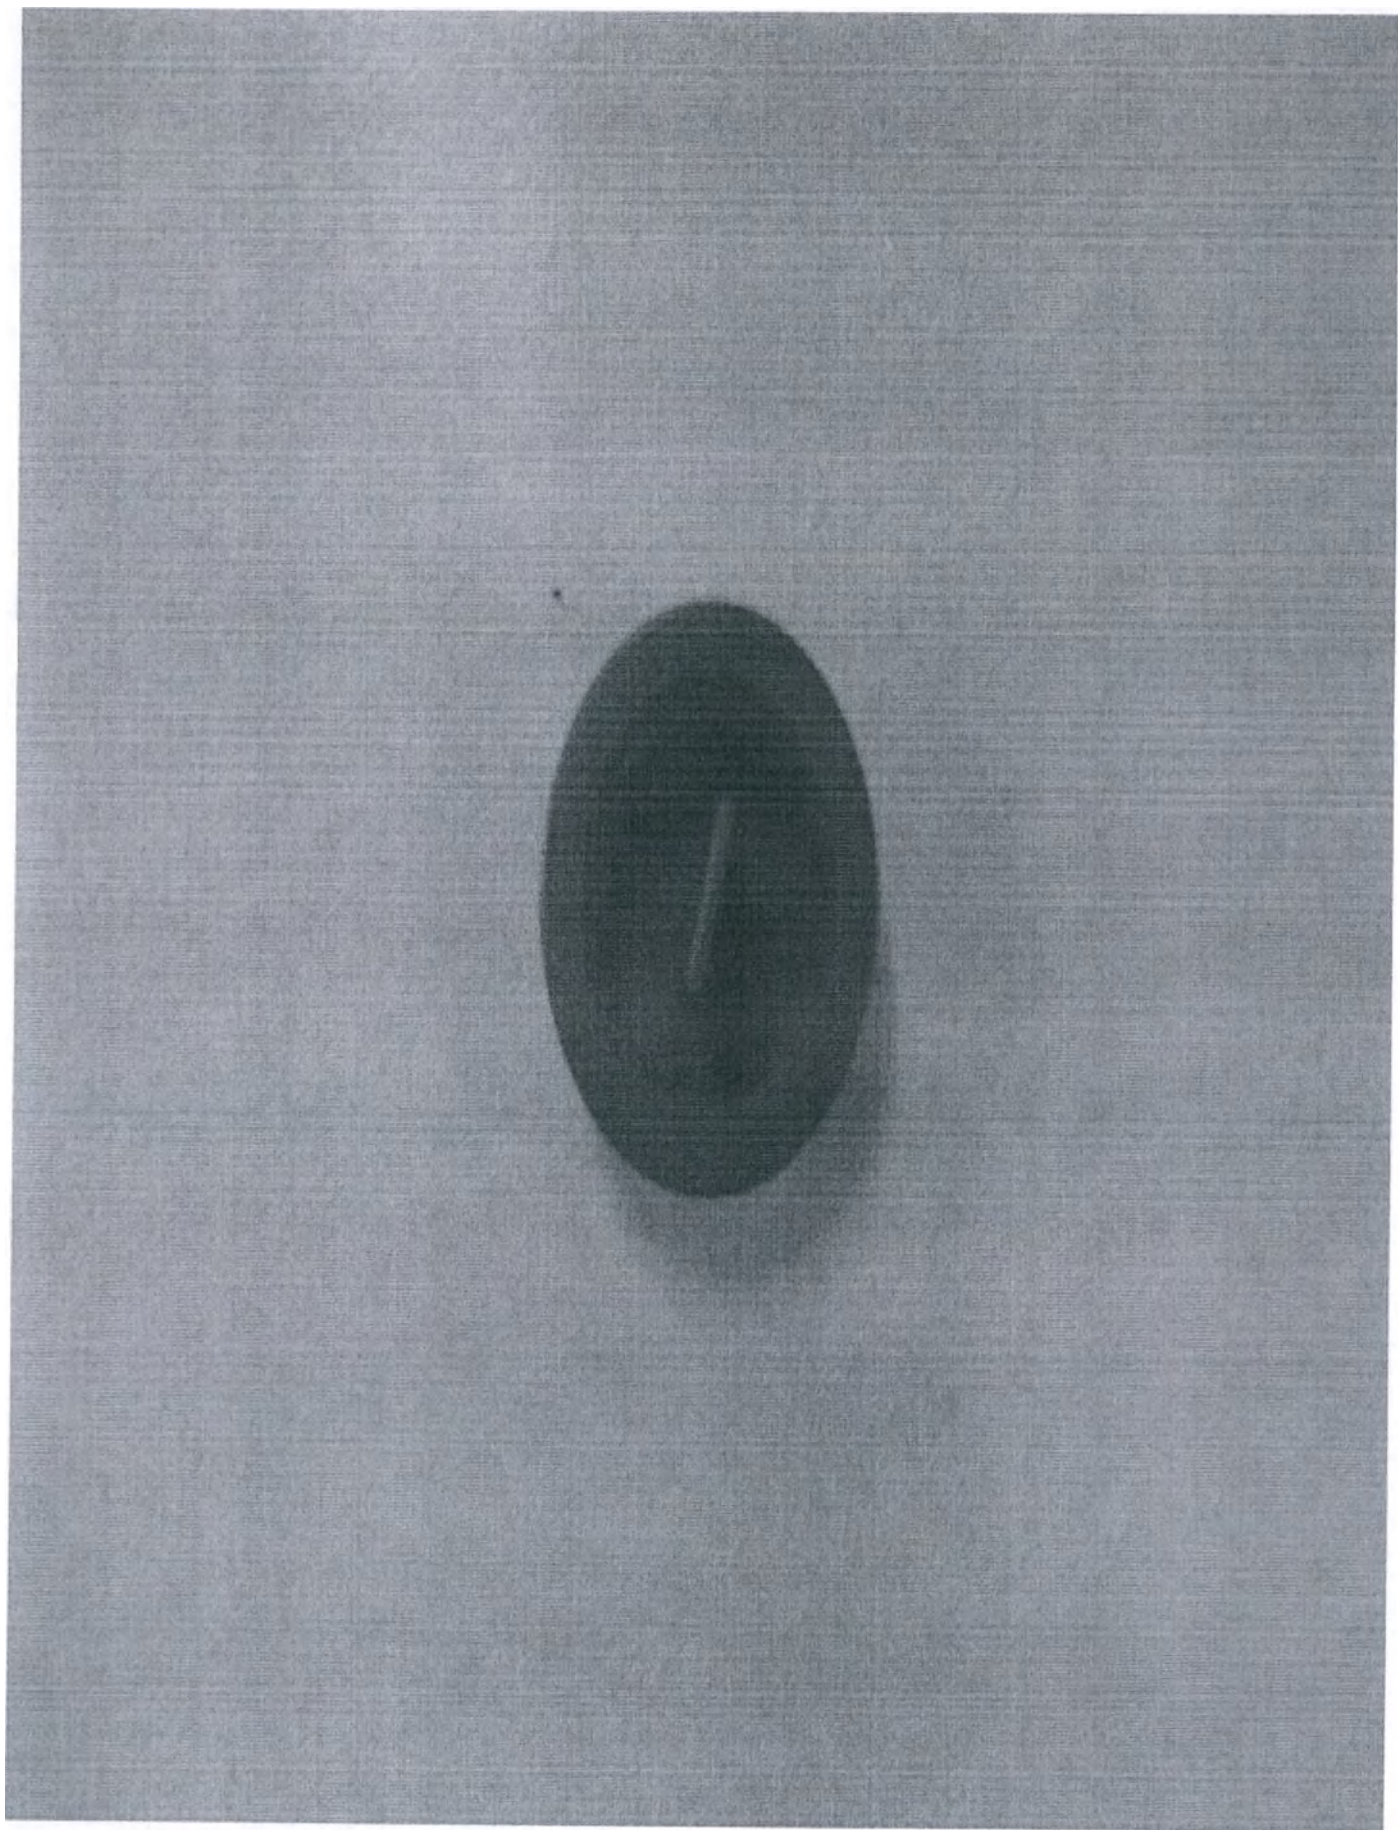


Рисунок 14. Емкость для воды (1л)

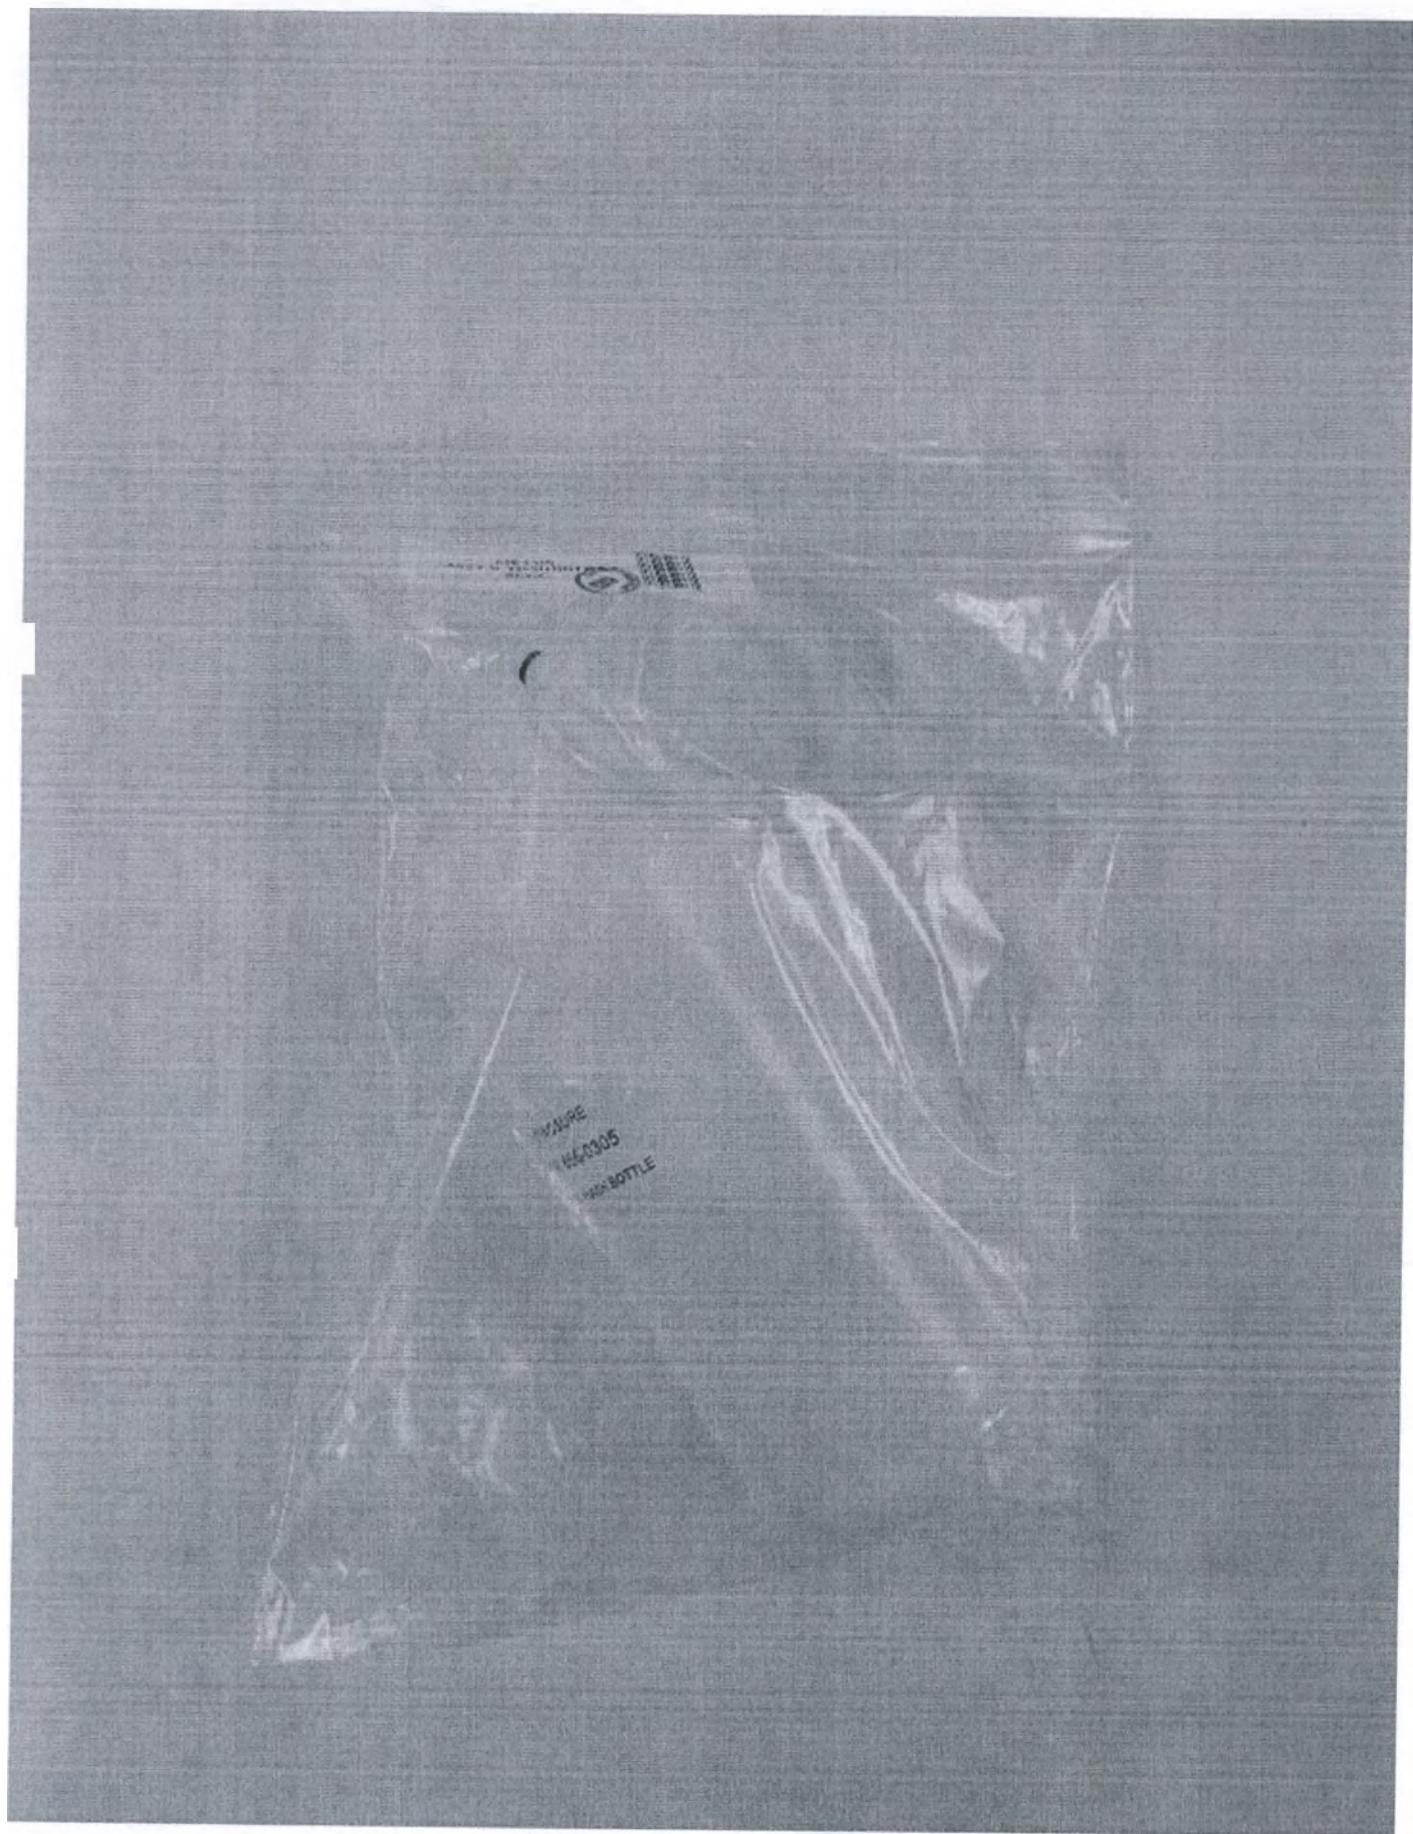


Рисунок 14.1. Маркировка емкости для воды (1 л)

Cynosure, LLC
P/N: 656-0305
Assy, 1L WASH BOTTLE

Рисунок 15. Держатель провода

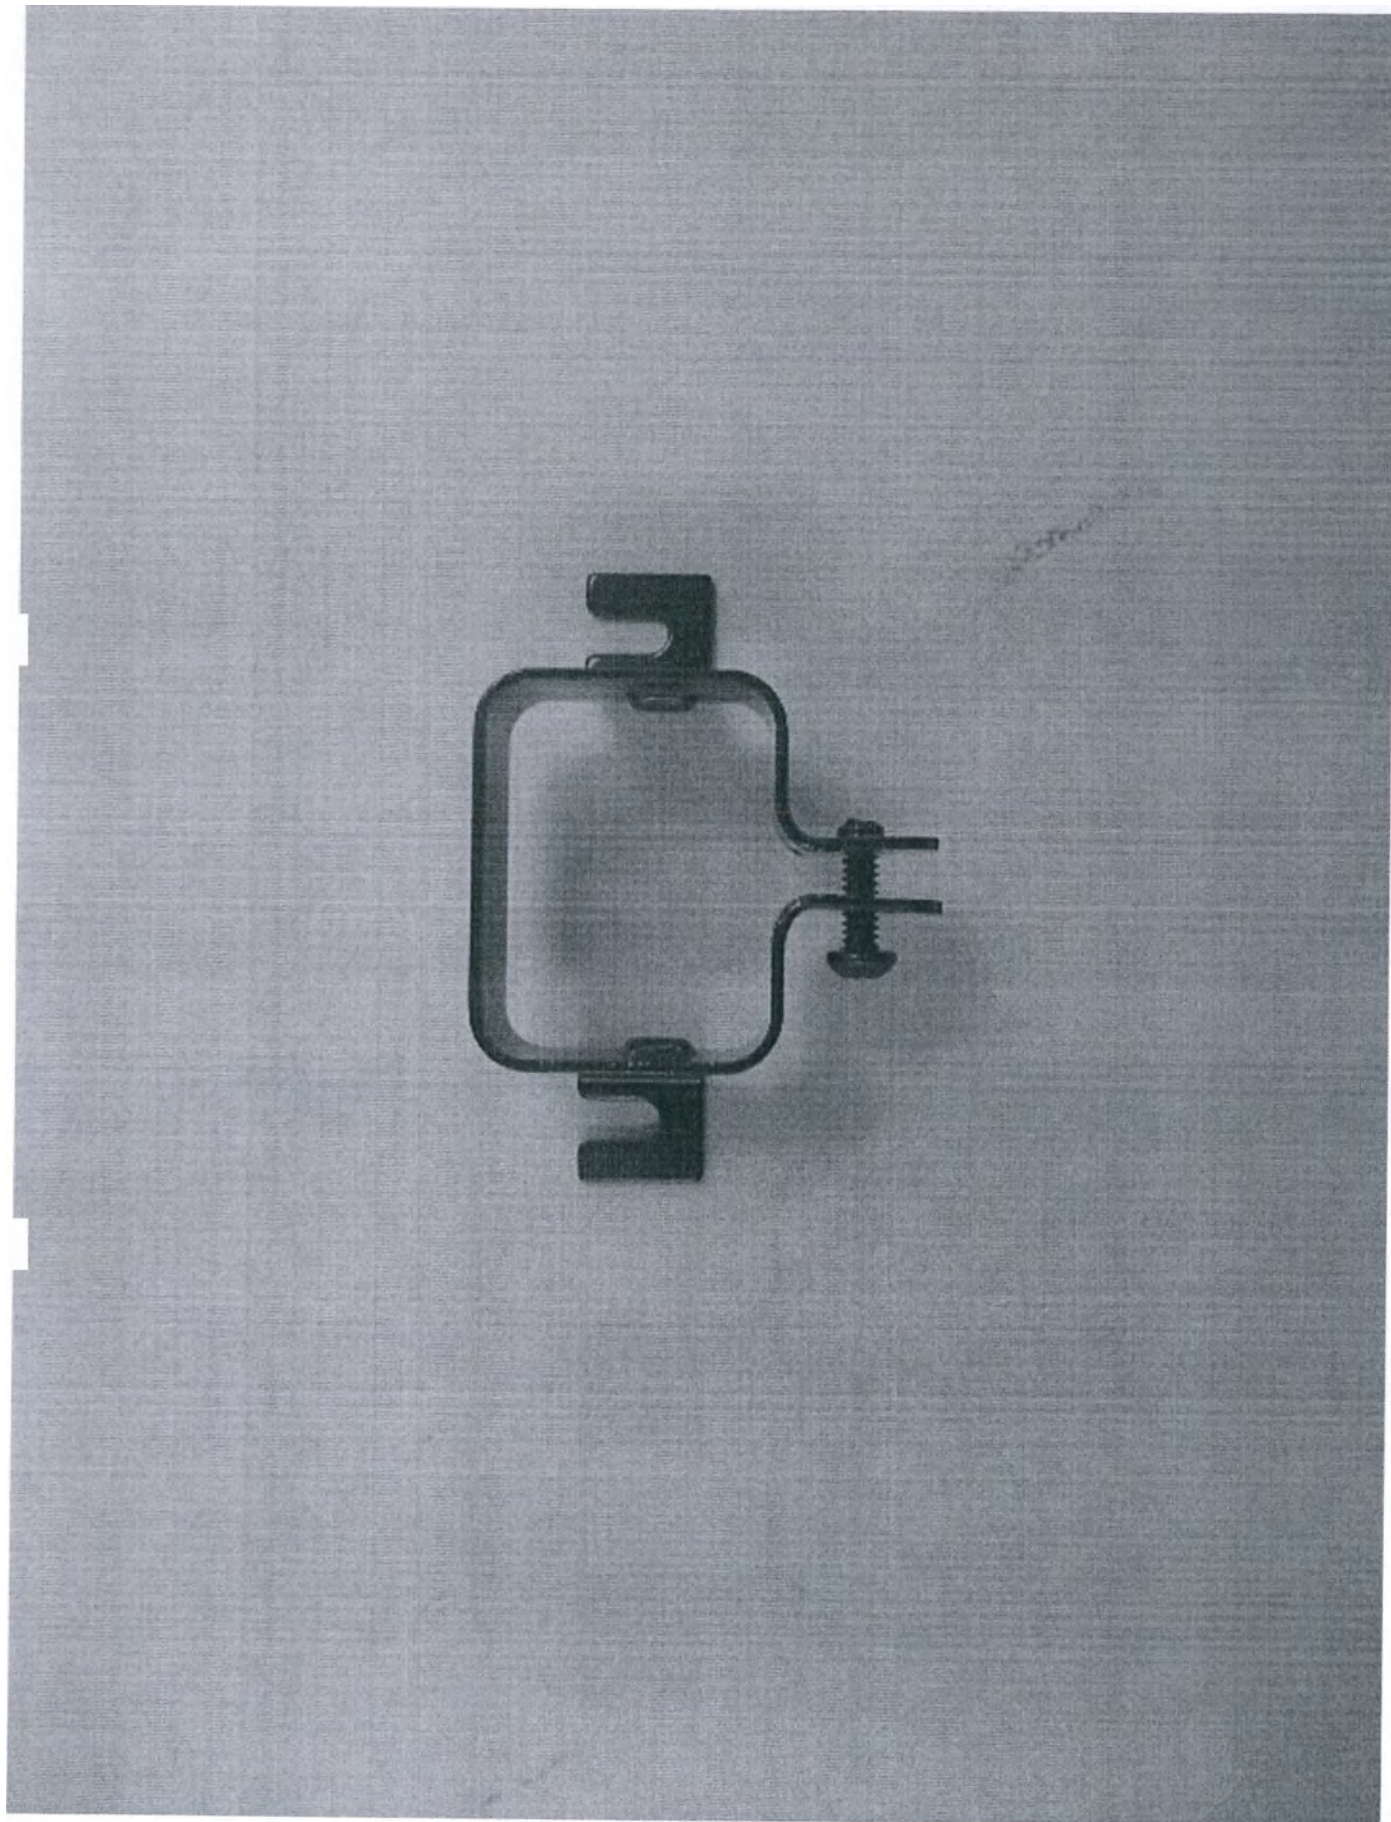


Рисунок 16. Ножная педаль

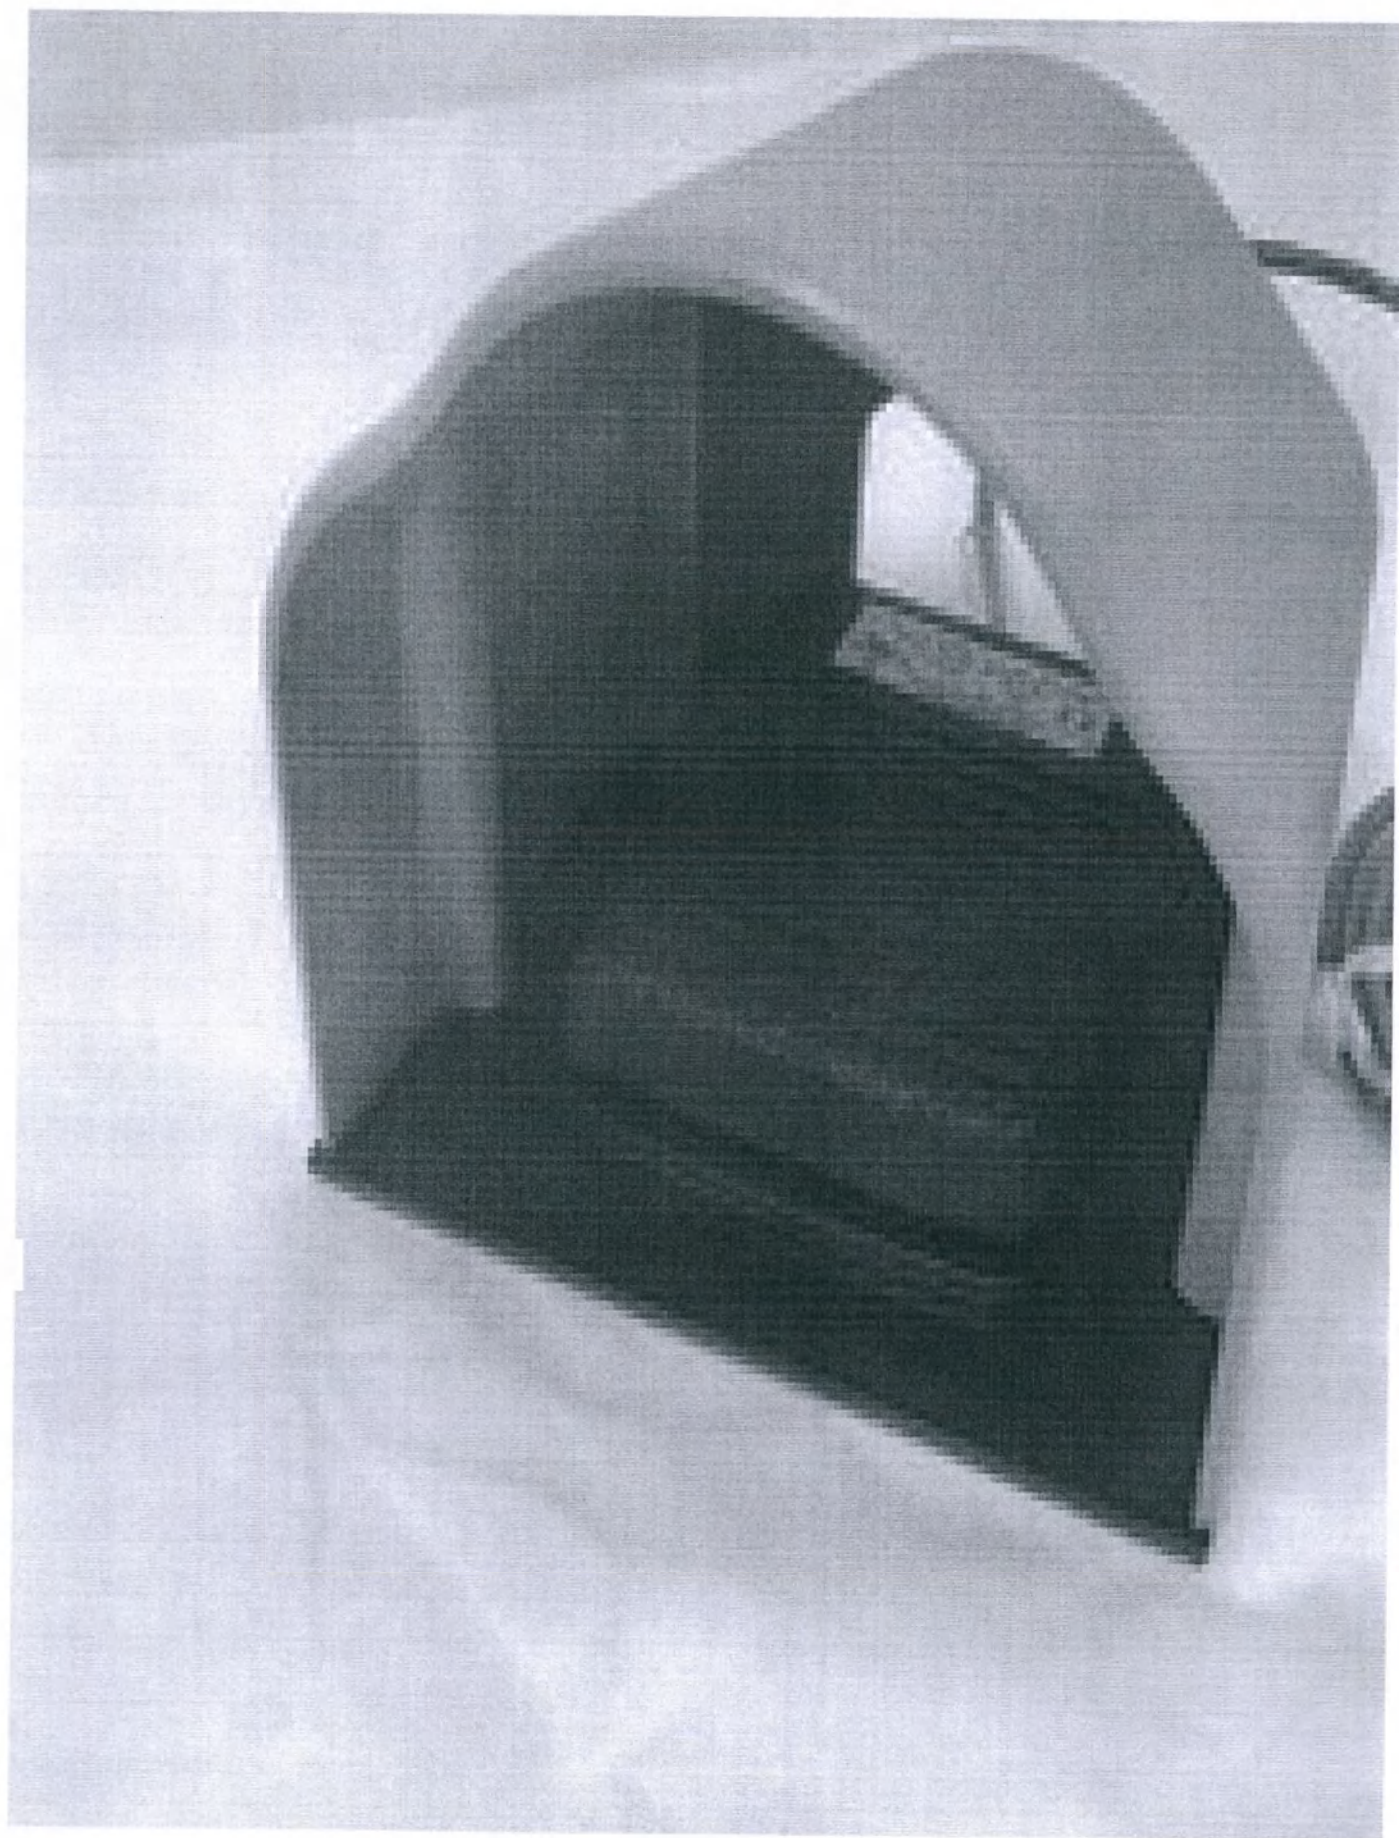


Рисунок 16.1. Маркировка ножной педали

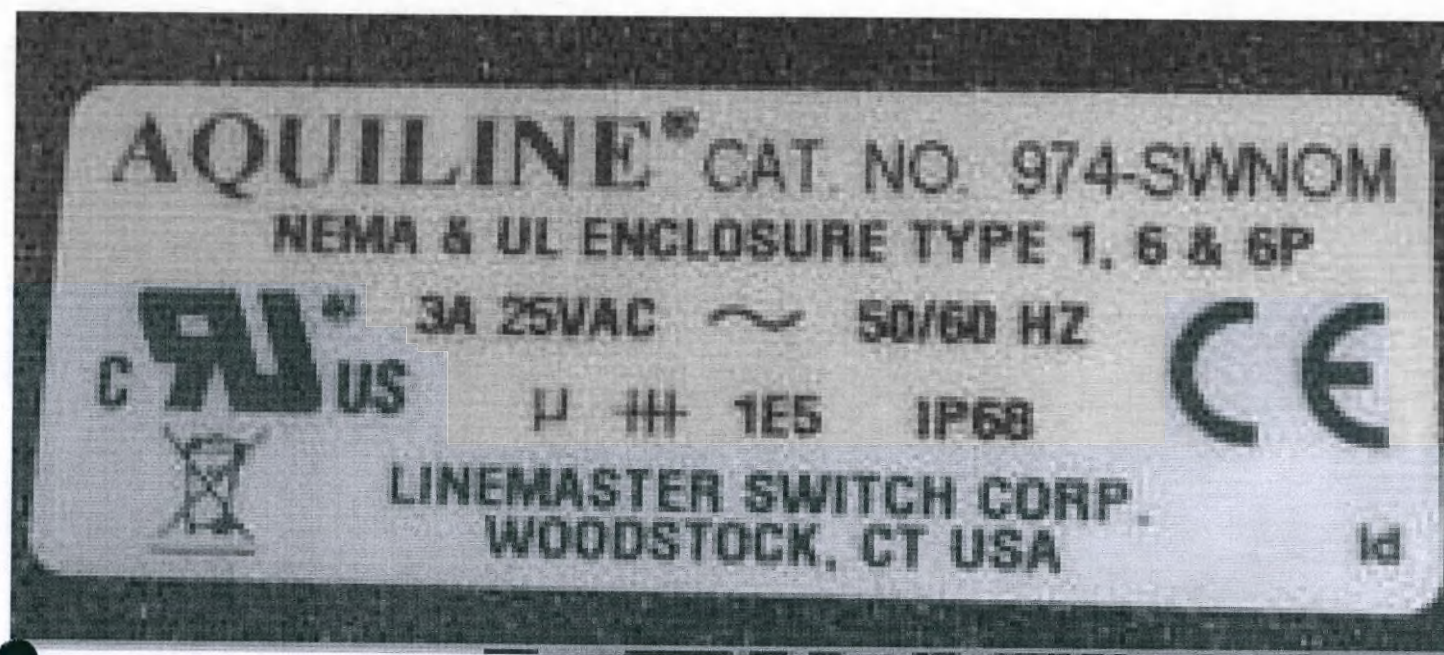


Рисунок 17. Кабель ножной педали



Рисунок 18. Держатель основания устройства доставки и позиционирования

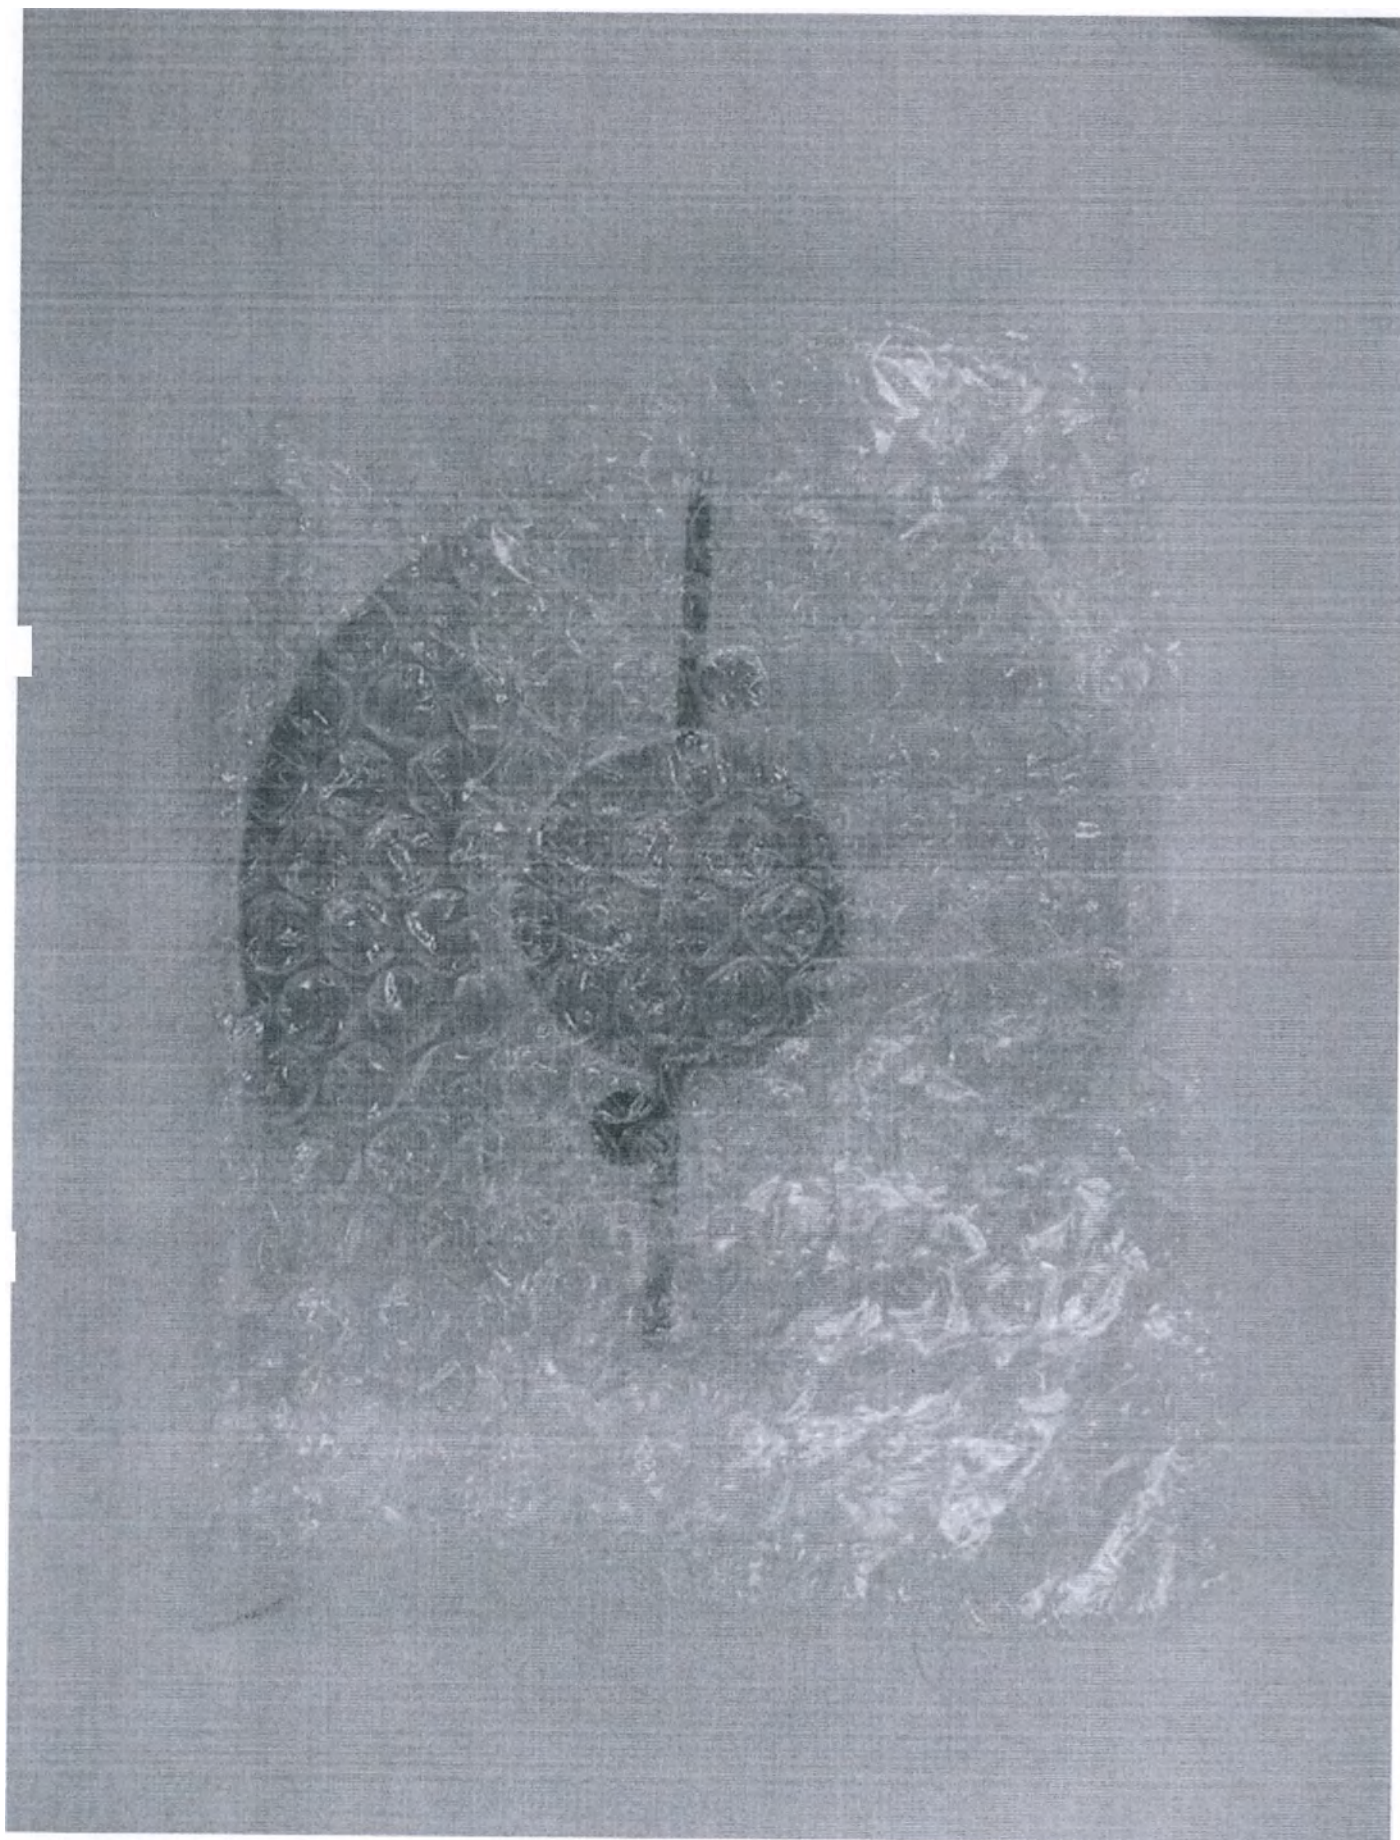


Рисунок 19. Феррит 18.3ММ

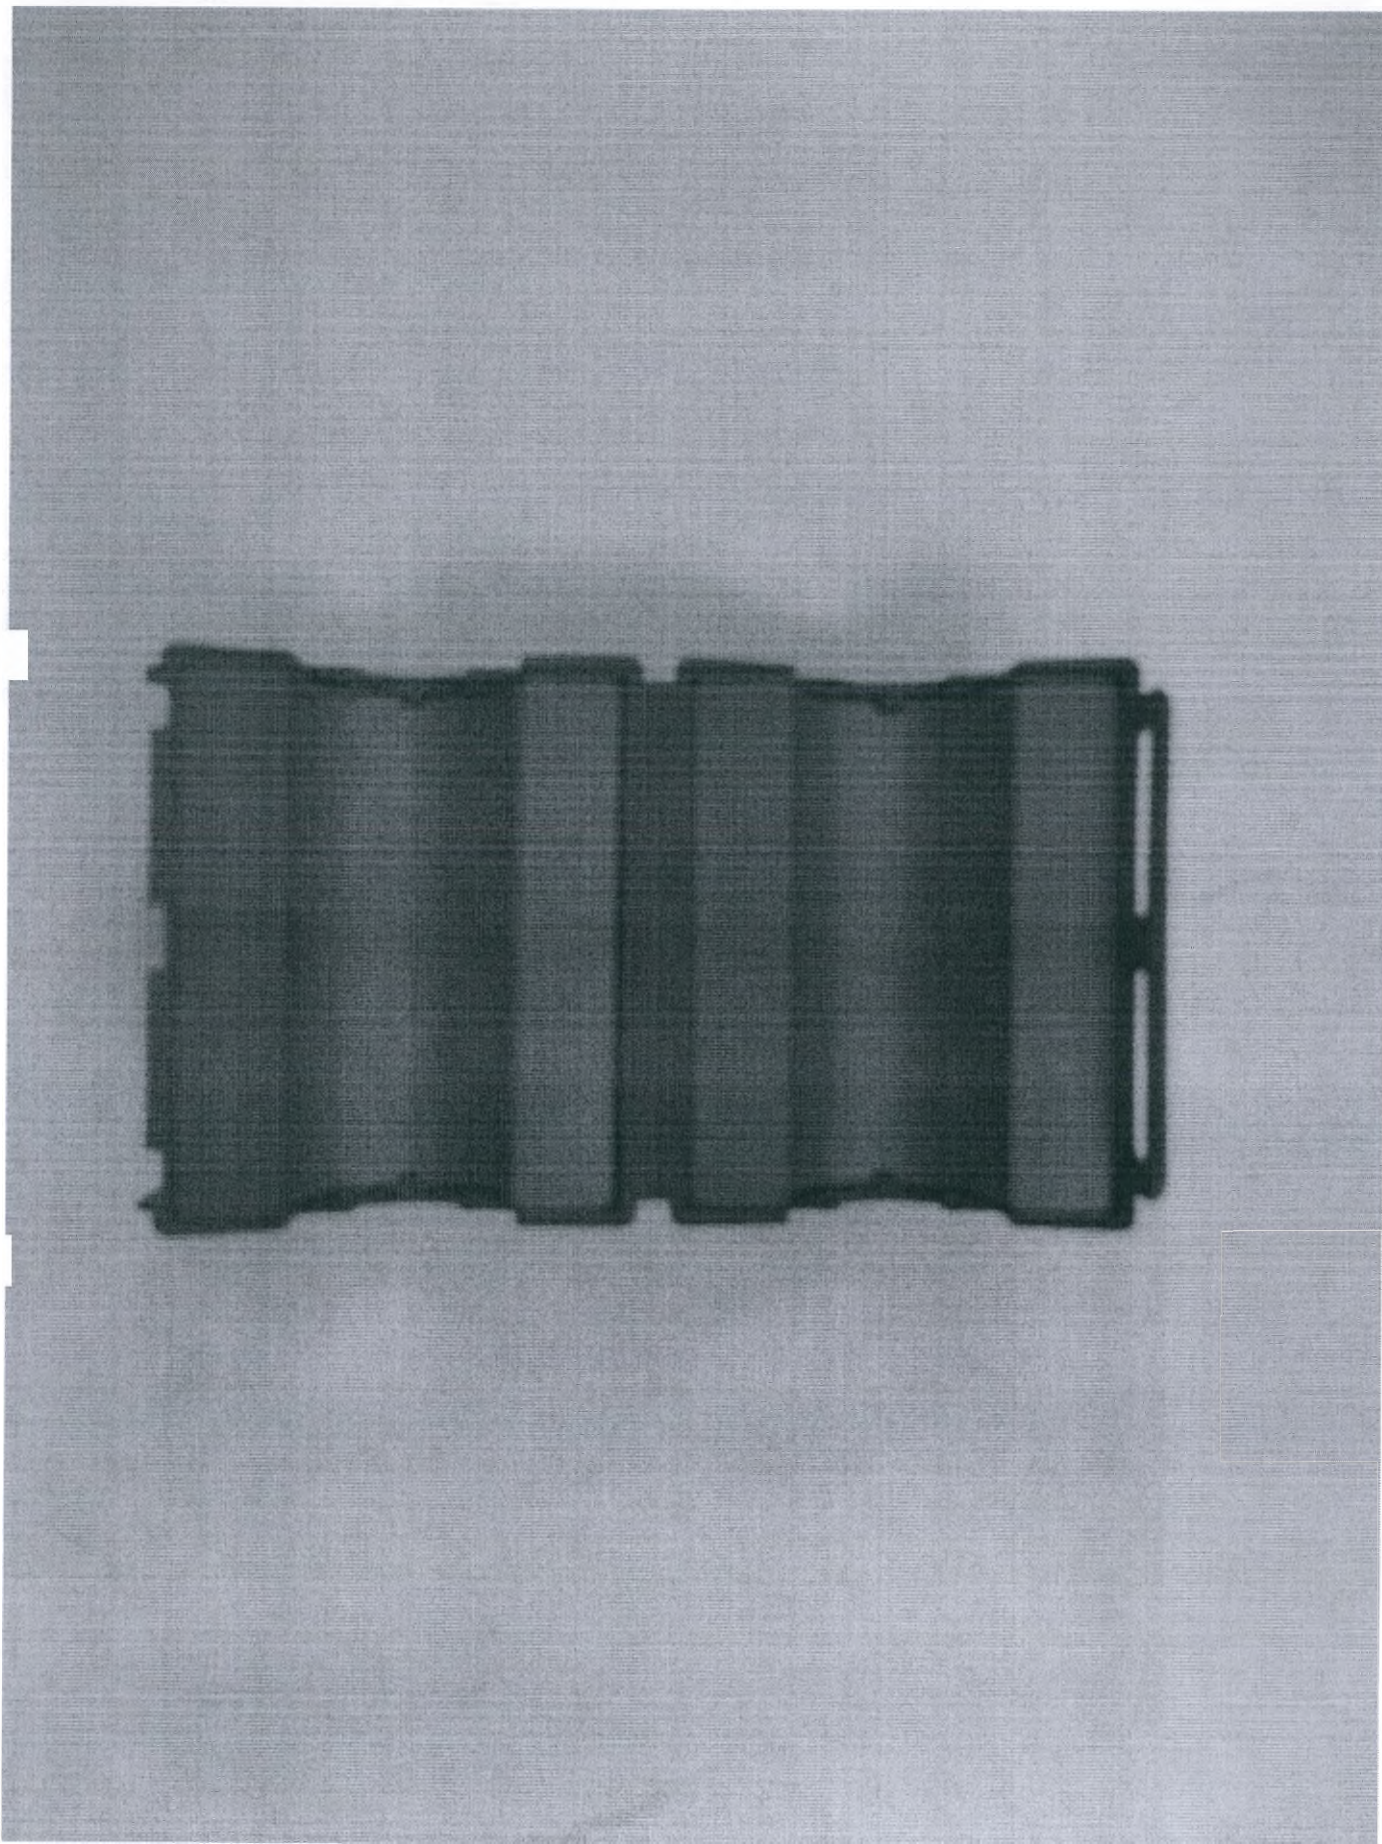


Рисунок 20. Феррит

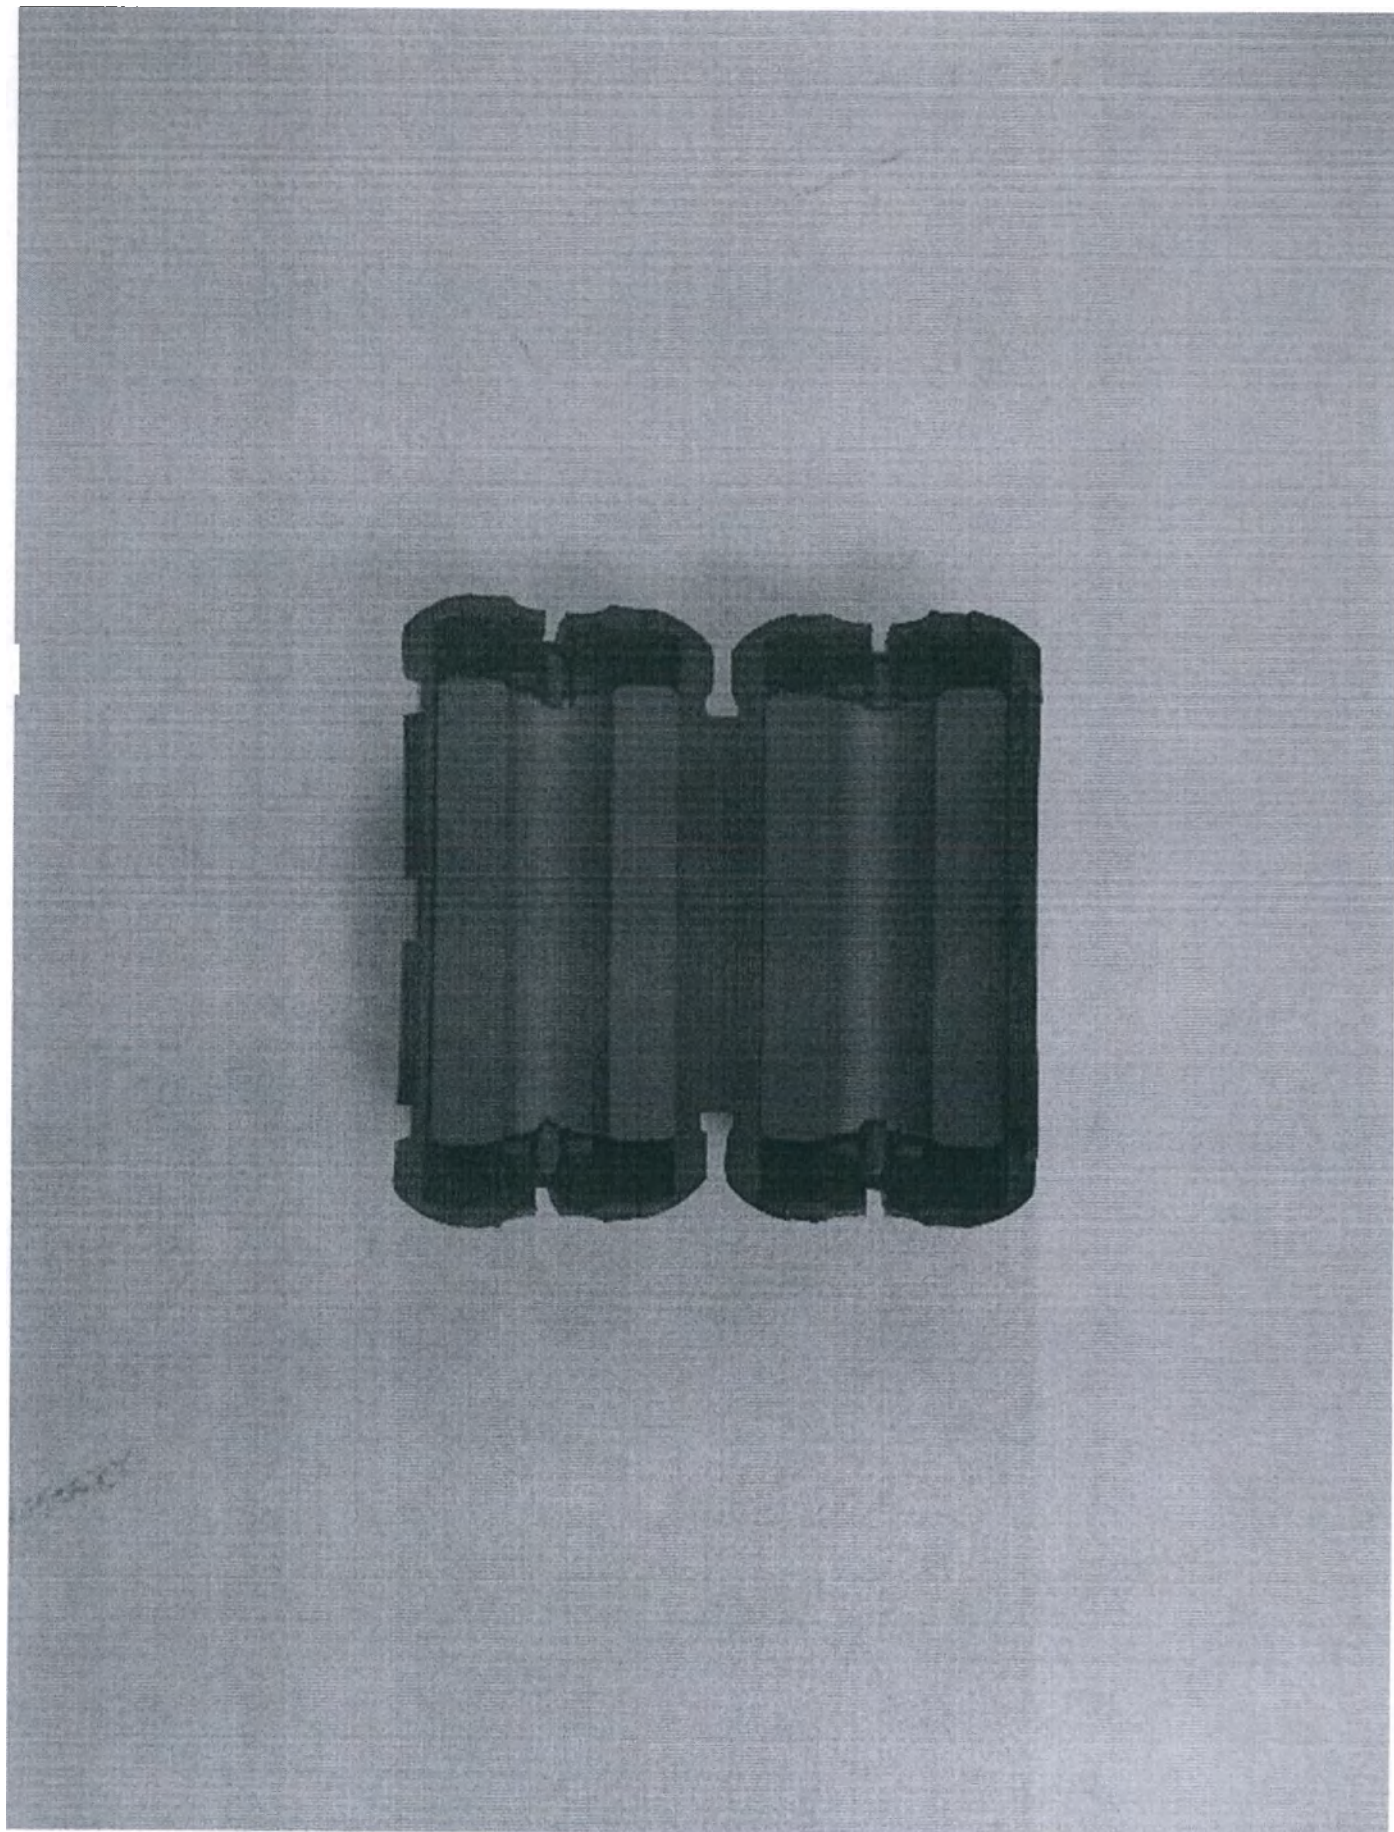


Рисунок 21. Ремешок для кабеля

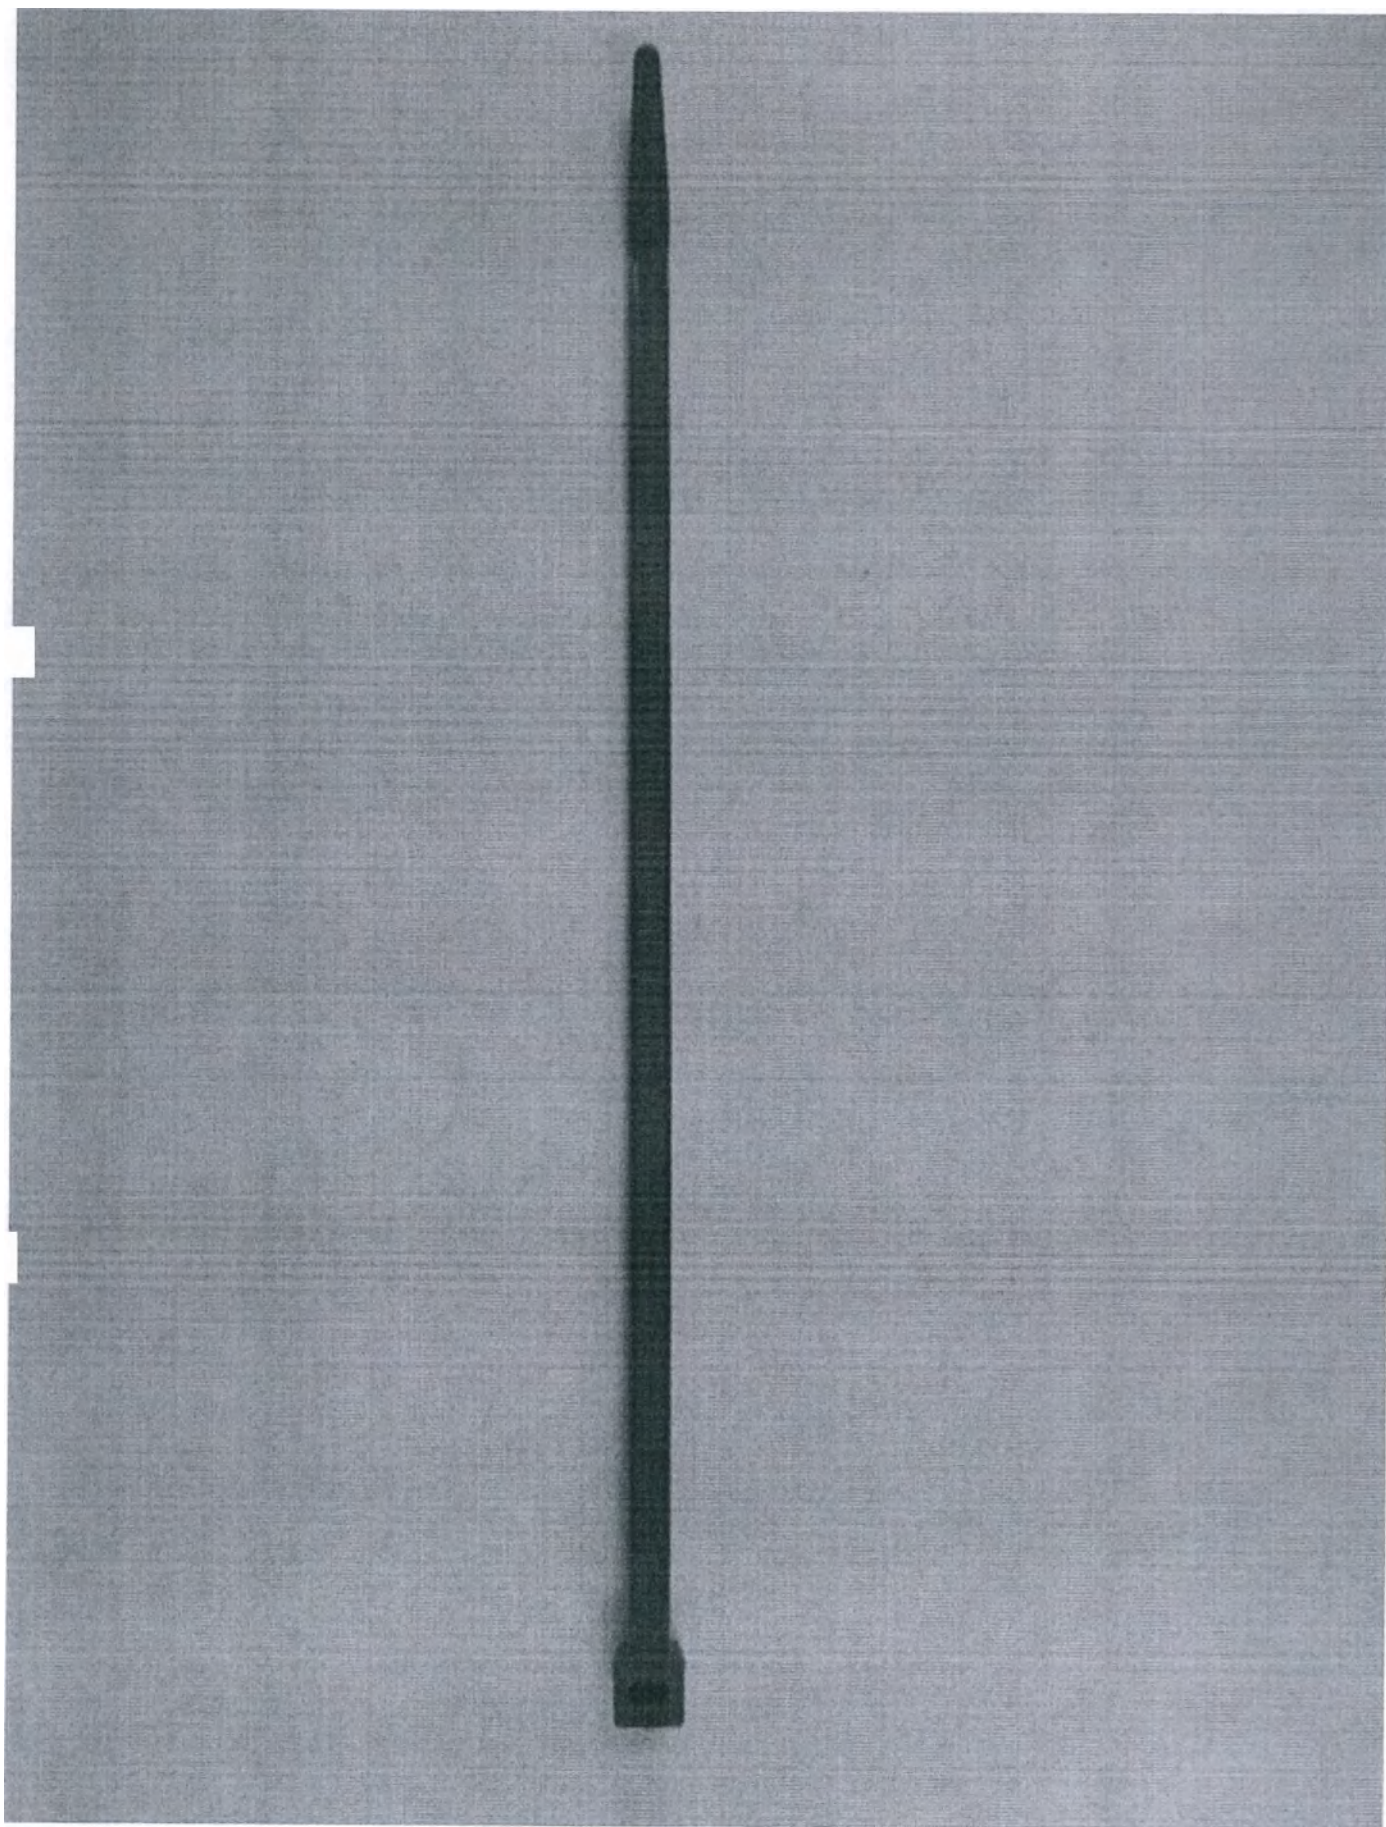



Рисунок 22. Руководство по эксплуатации

CYNOSURE, LLC
5 Carlisle Road, Westford,
MA 01886 USA

"I certify"

Cynosure, LLC
Chief Executive Officer
Todd Tillemans
«Утверждаю»
Сайнашуар, Эл-Эл-Си
Генеральный директор
Тод Тилман

 10 January 2023

АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ REVLITE SI

Руководство по эксплуатации медицинского изделия

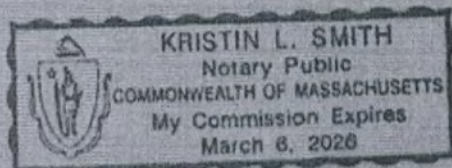


Рисунок 23. Руководство по клиническому применению



CYNOSURE, LLC
5 Carlisle Road, Westford,
MA 01886 USA

"I certify"

Cynosure, LLC

Chief Executive Officer

Todd Tillemans

«Утверждаю»

Сайнашуар, Эл-Эл-Си

Генеральный директор

Тод Тилман

Todd W. Tillemans 10 January 2023

REOLITE

Руководство по установке

Аппарат лазерный медицинский
RevLite SI

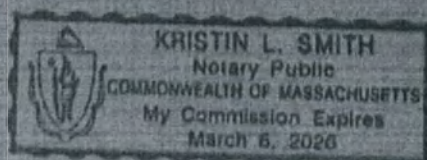


Рисунок 25. Винт М3Х8ММ

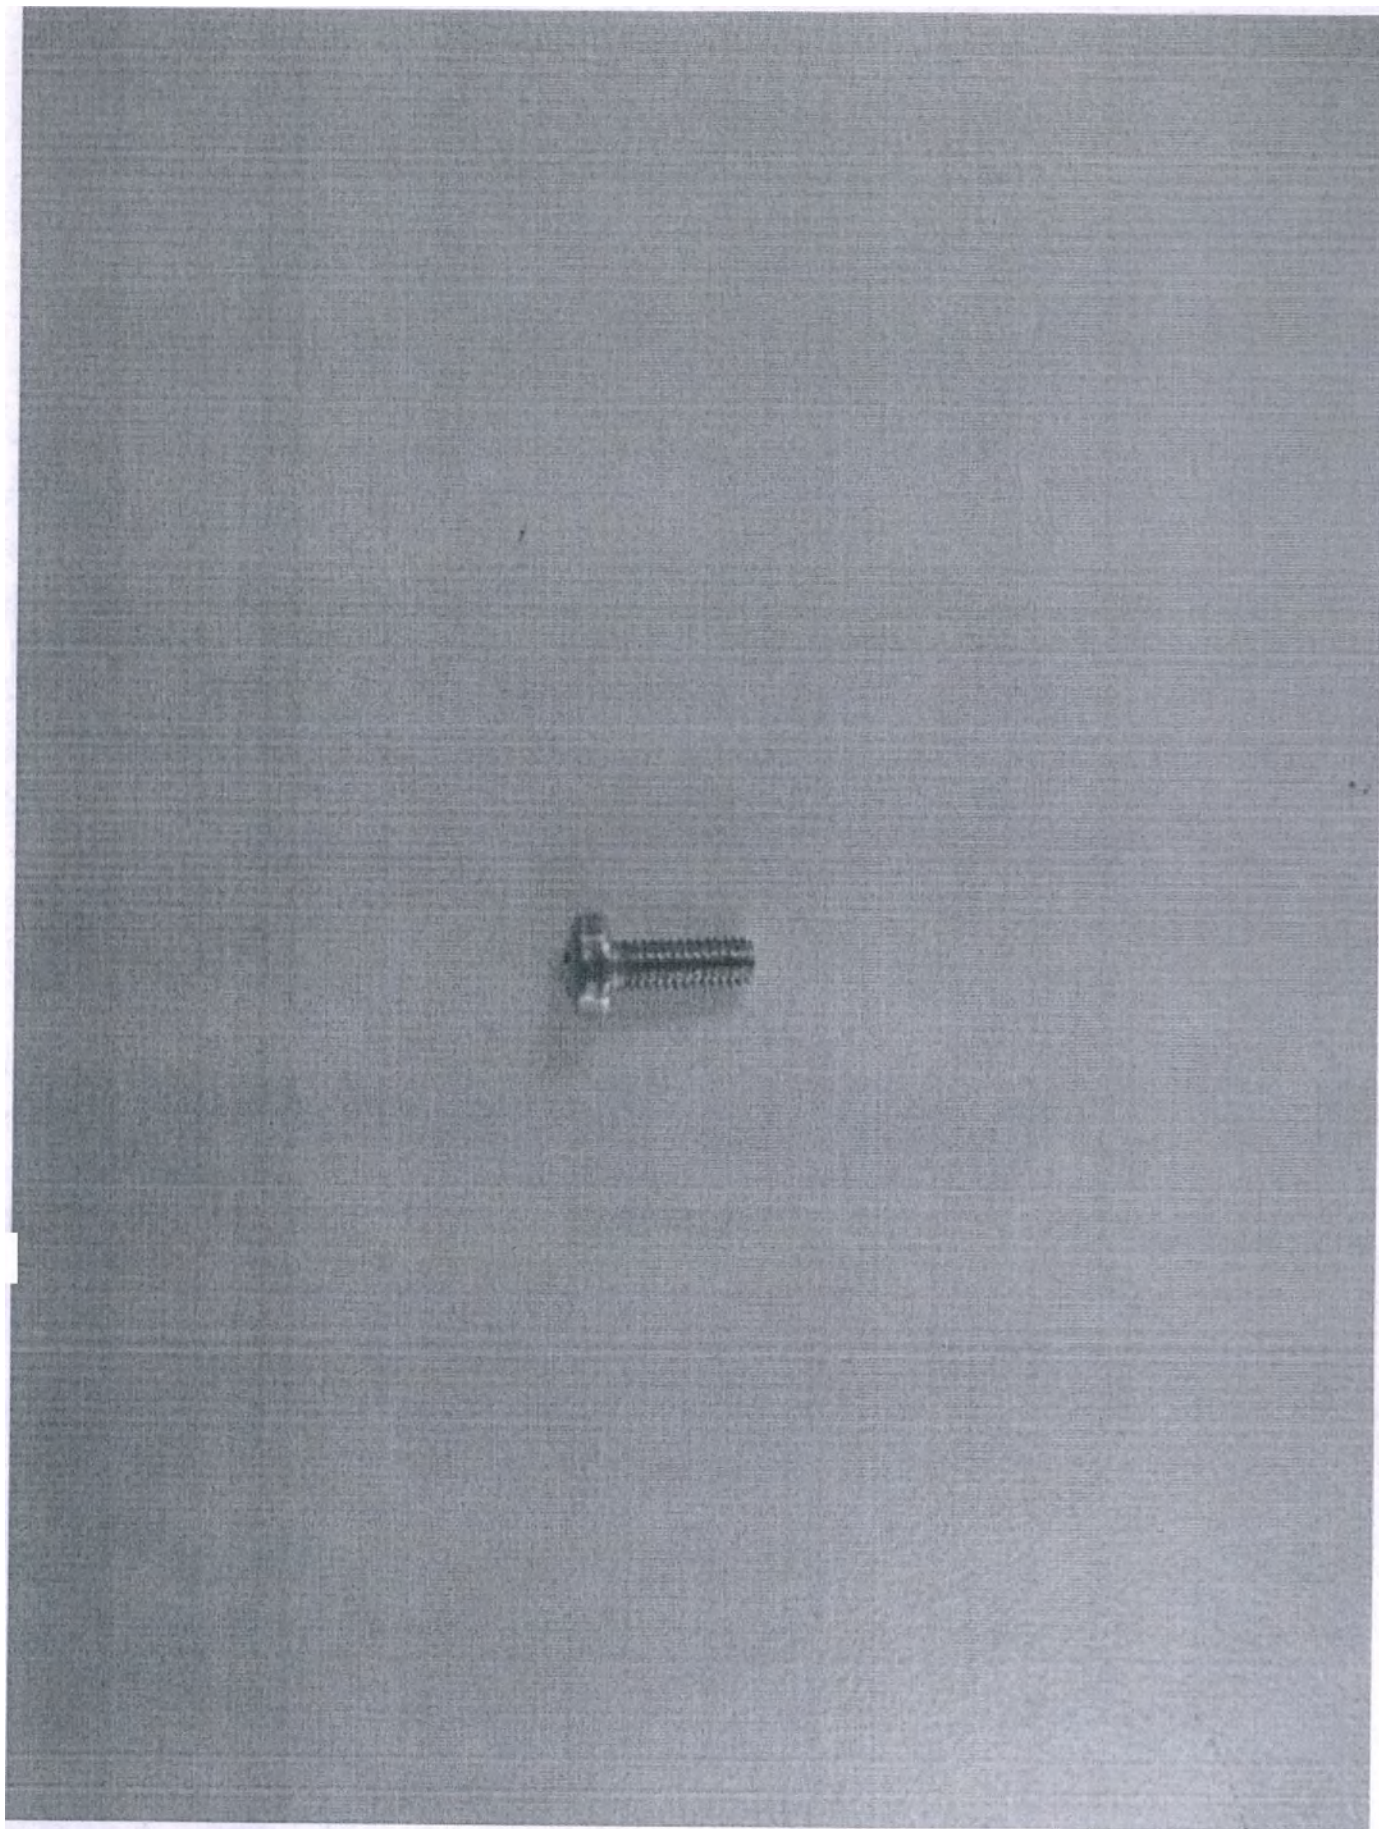


Рисунок 26. Защитные шильды для пациента

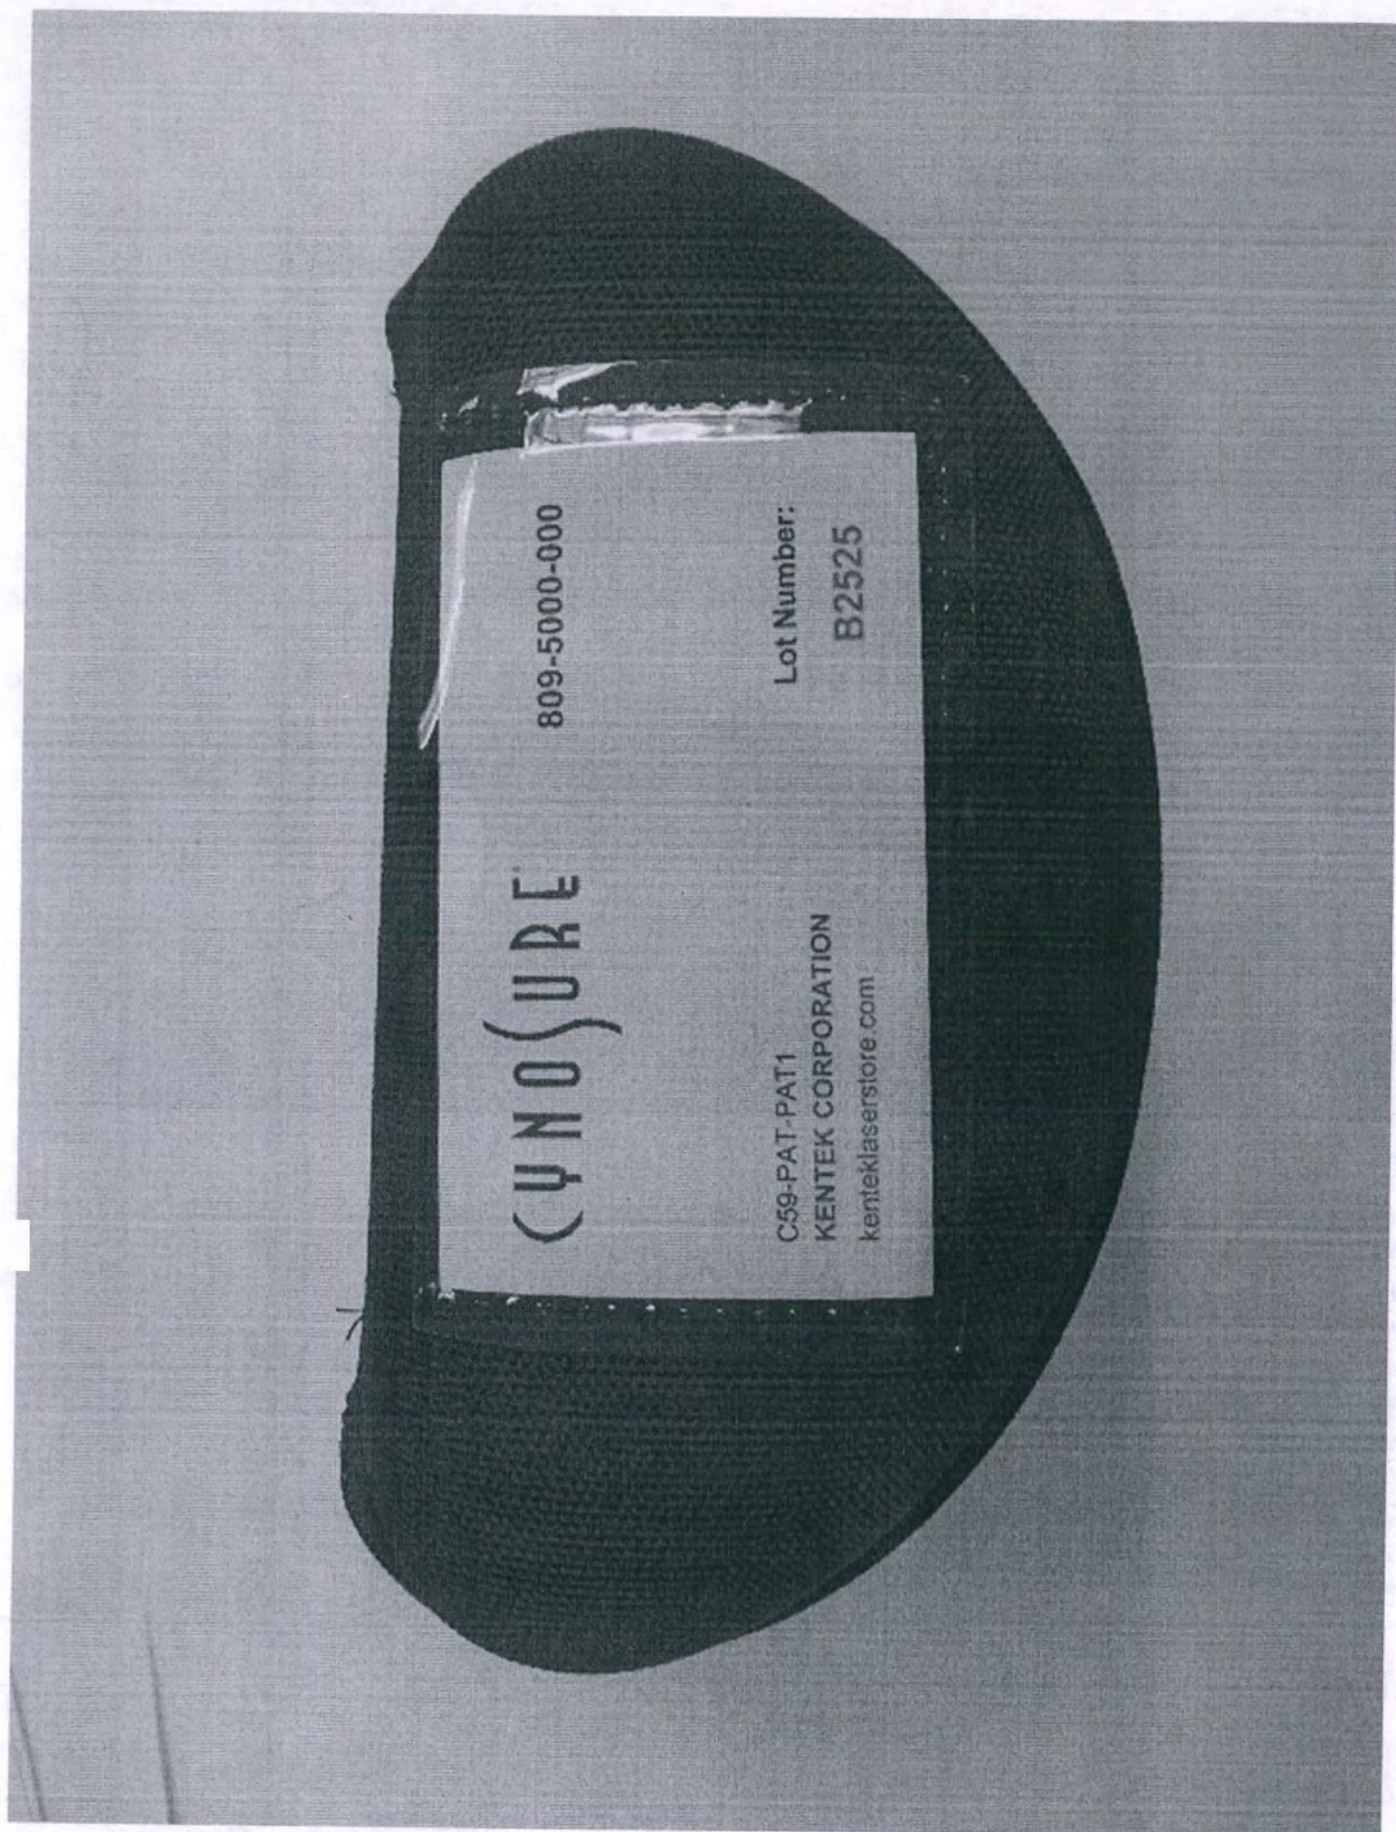


Рисунок 27. Зажим



Рисунок 28. Кабель питания

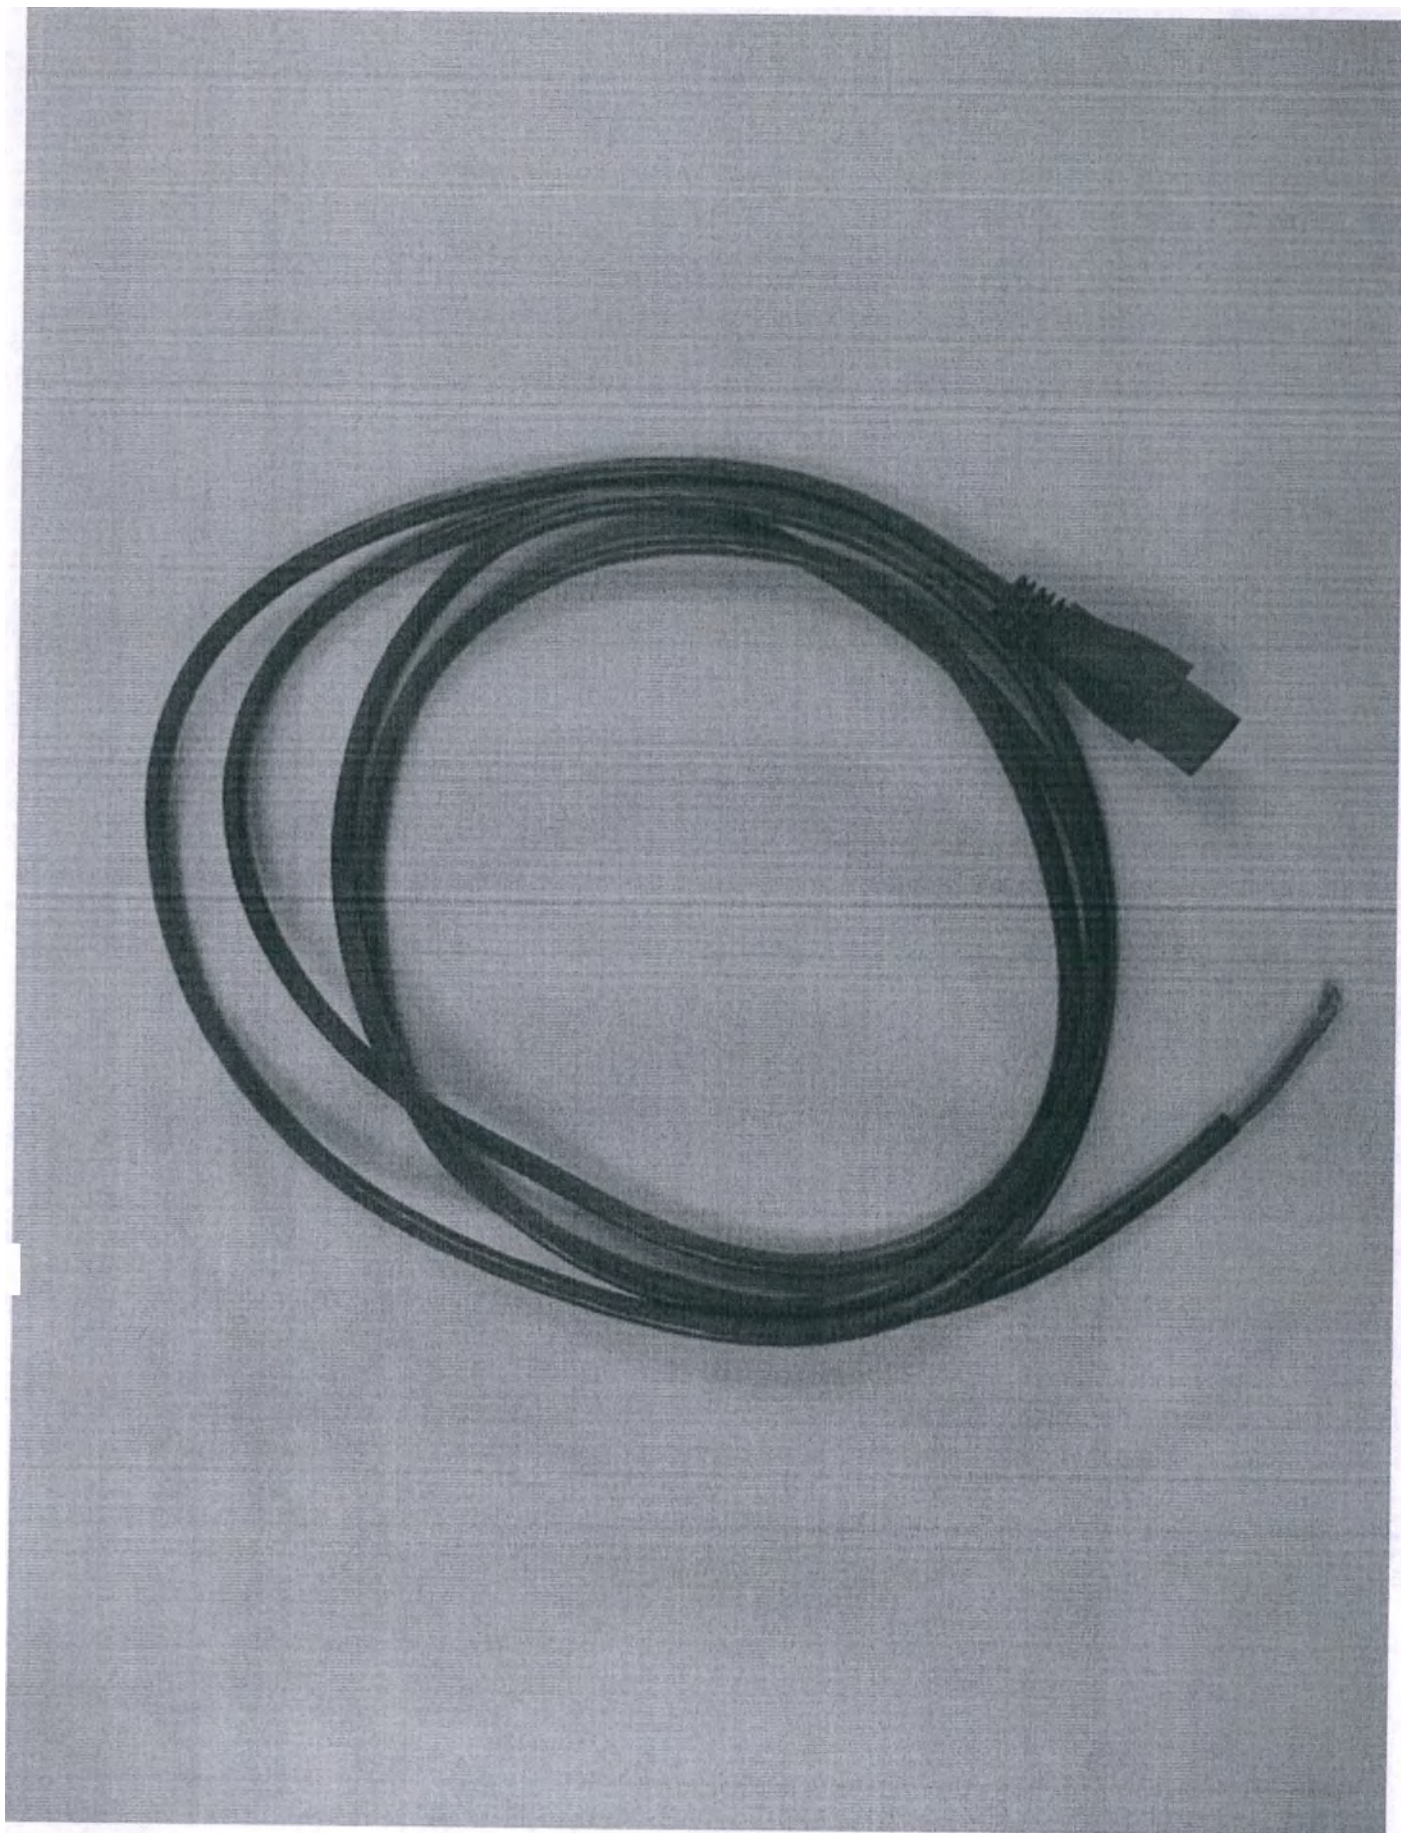


Рисунок 29. Очки защитные 585 нм (чехол)



Рисунок 29.1 Очки защитные 585 нм


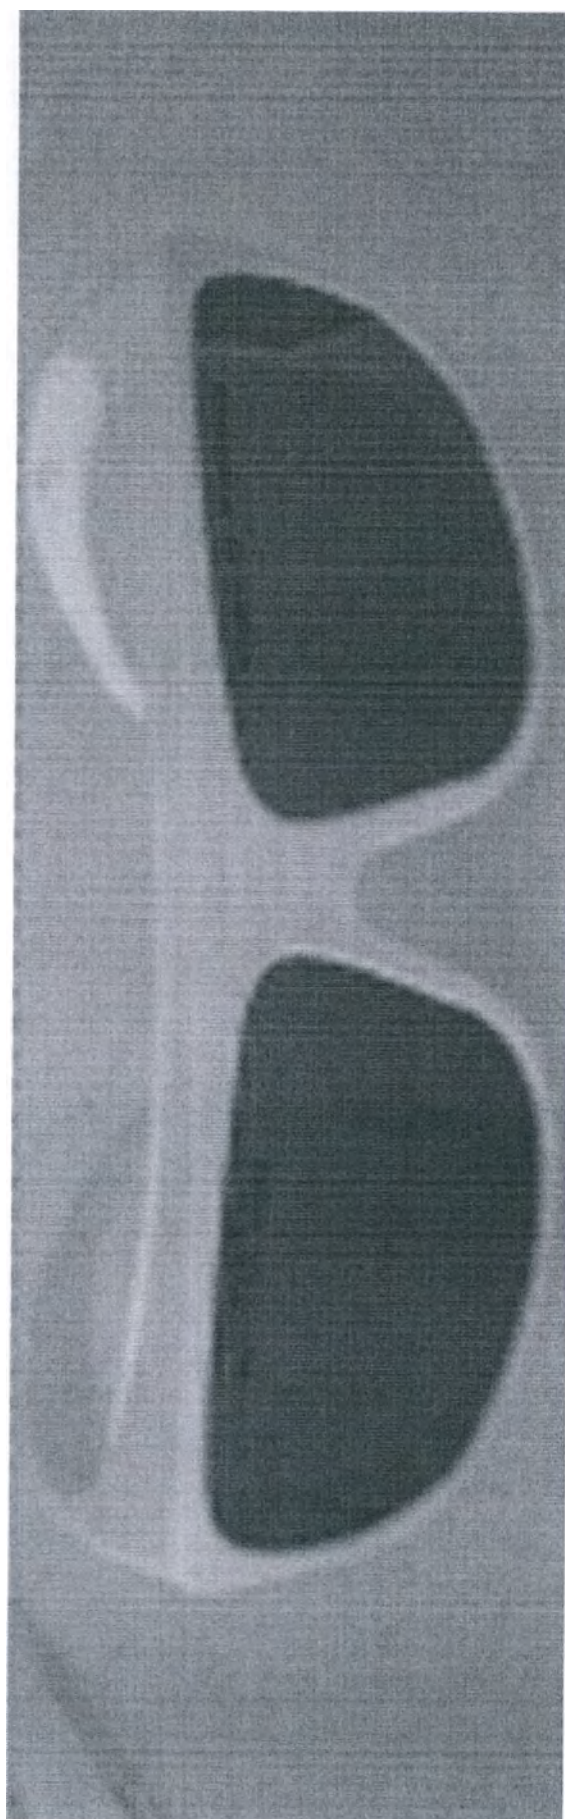


Рисунок 30. Защитные очки 1064+532 нм



Рисунок 32. Манипула на красителях MultiLite (красная)

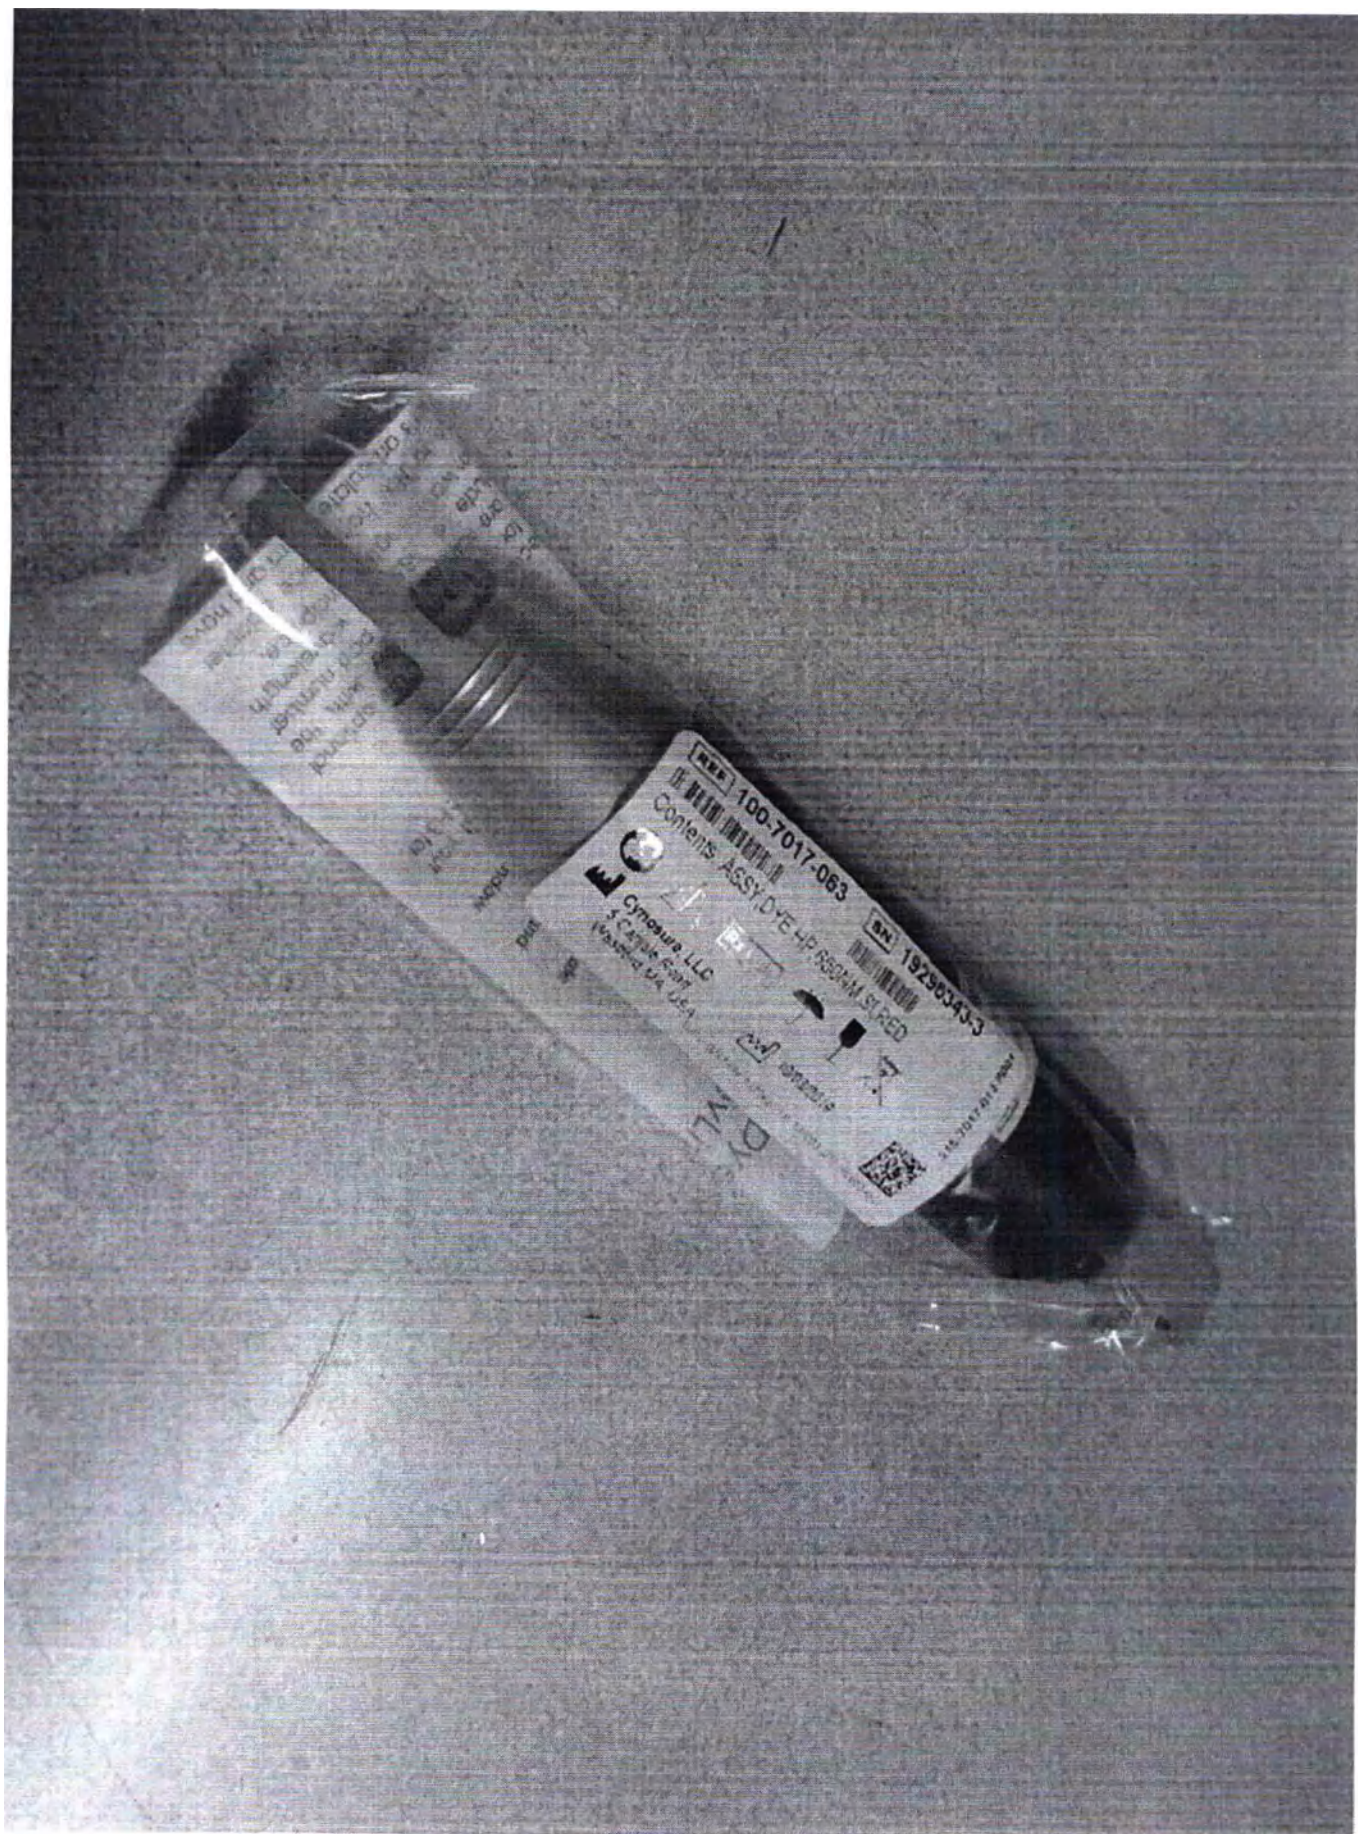

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
Всего 36 л.

Генеральный директор ООО «ЮМТЕКС»
Захарченко Дмитрий Юрьевич

