



«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС»

Иващенко А.А.

«13» июня 2022 г.


Фотографии медицинского изделия:

«Стерилизаторы паровые "DGM"»

производства «Shinva Medical Instrument Co., Ltd.»/

«Шинва Медикал Инструмент Ко. Лтд», Китай

2022 г.

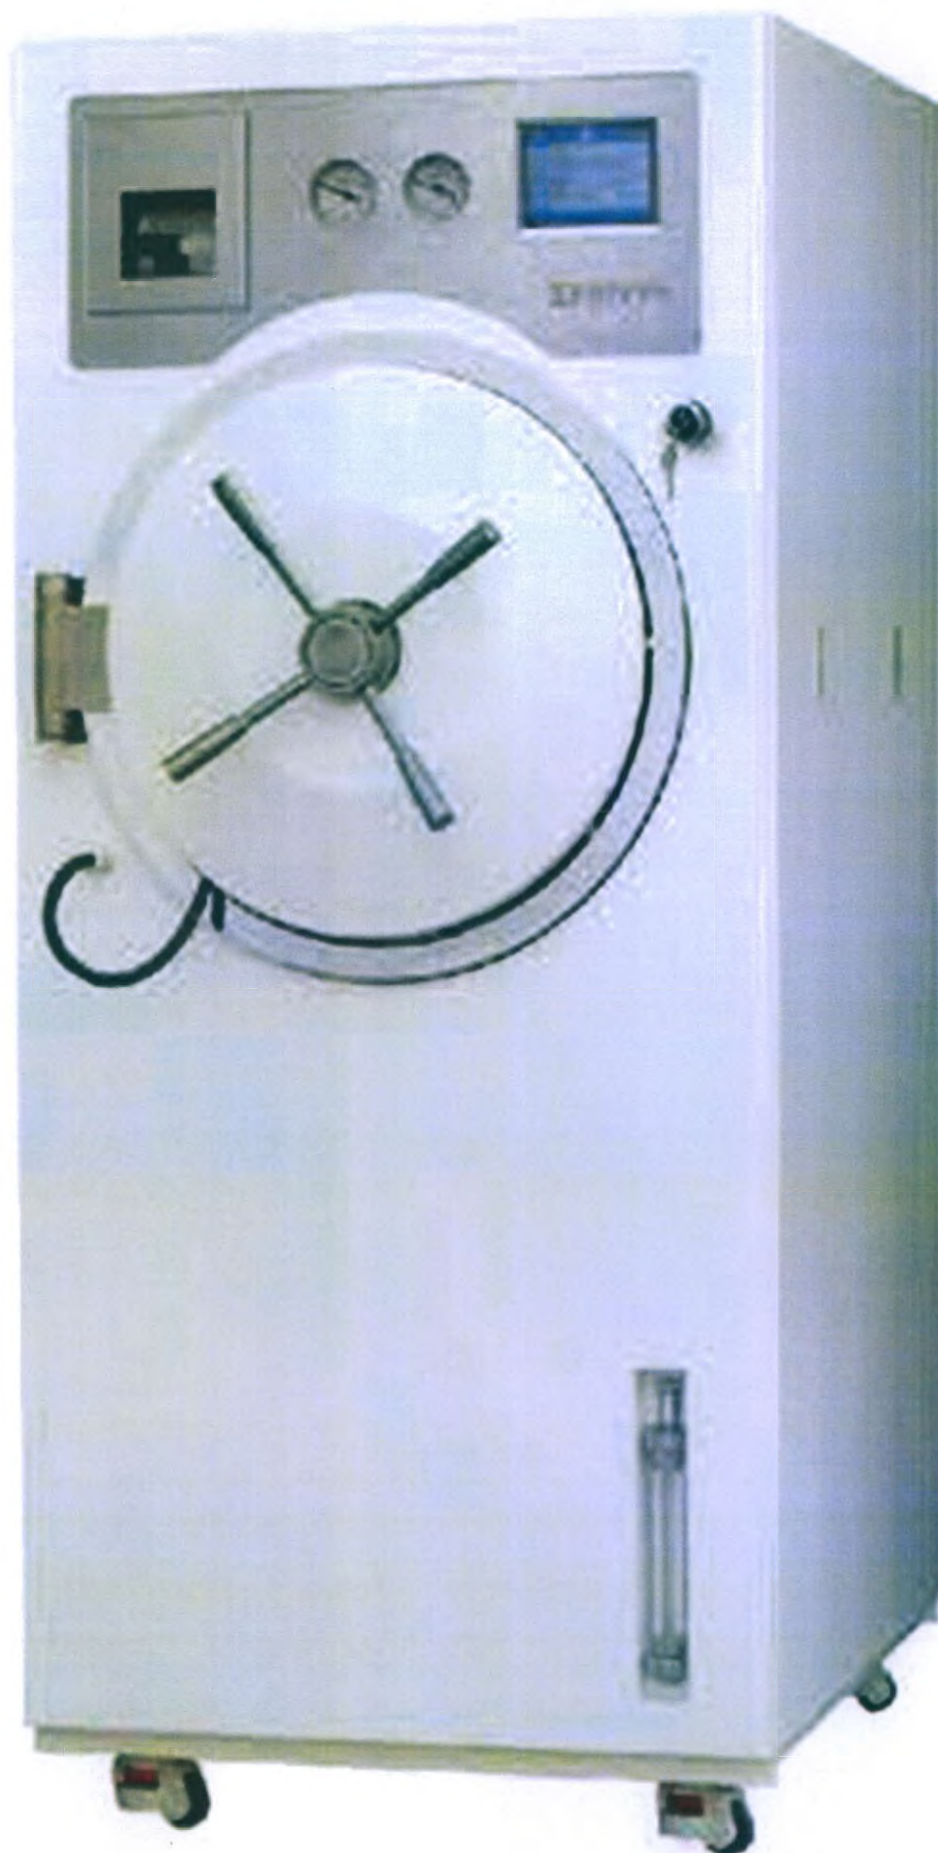


Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM – 100



Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM-130



Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM-240. Лицевая сторона (проходной, непроходной тип)

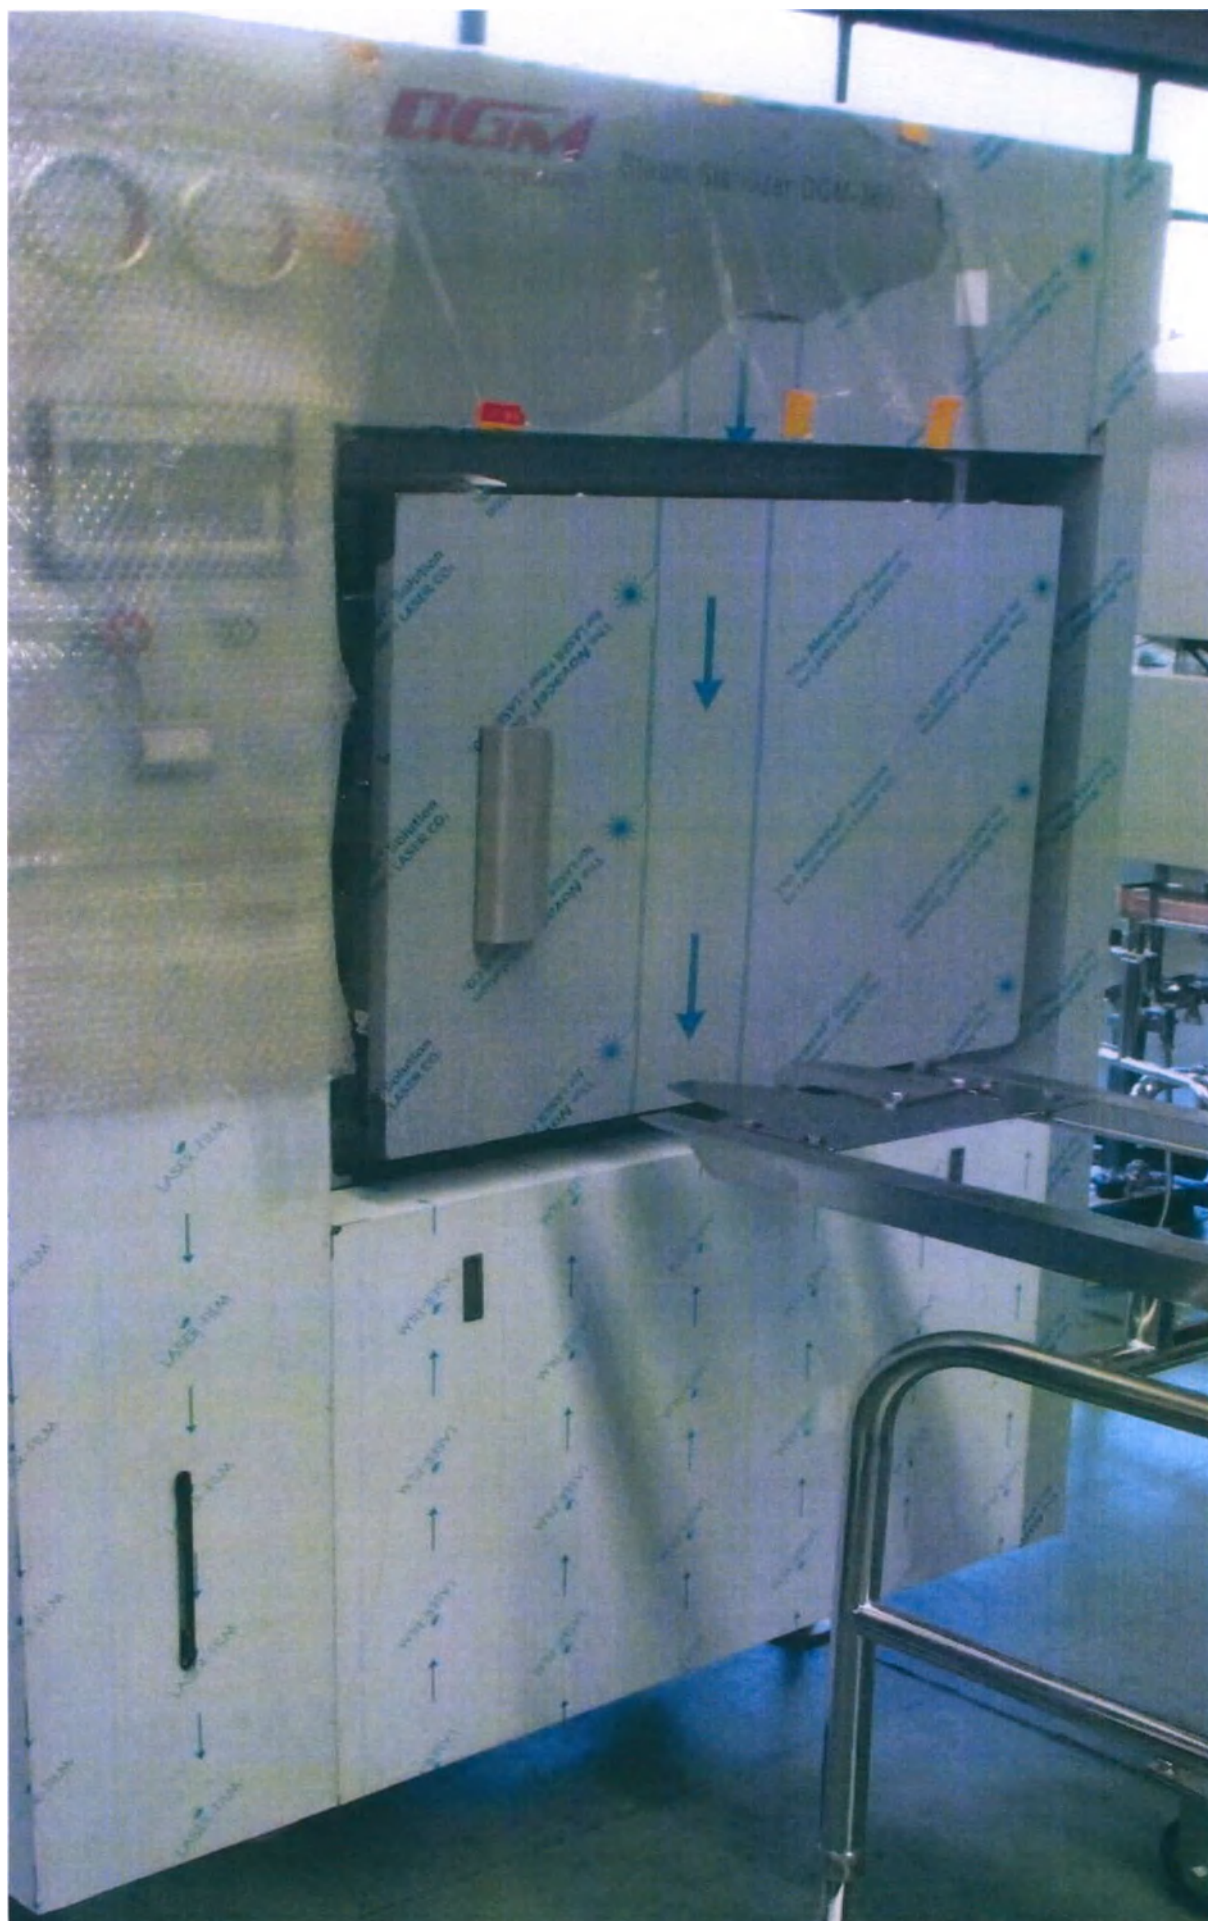

Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM-360



Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM-600



Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM-800



Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM-1000



Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM-1200




Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM-1500




Стерилизатор паровой «DGM» в следующем исполнении: DGM-2000




Бумага для принтера

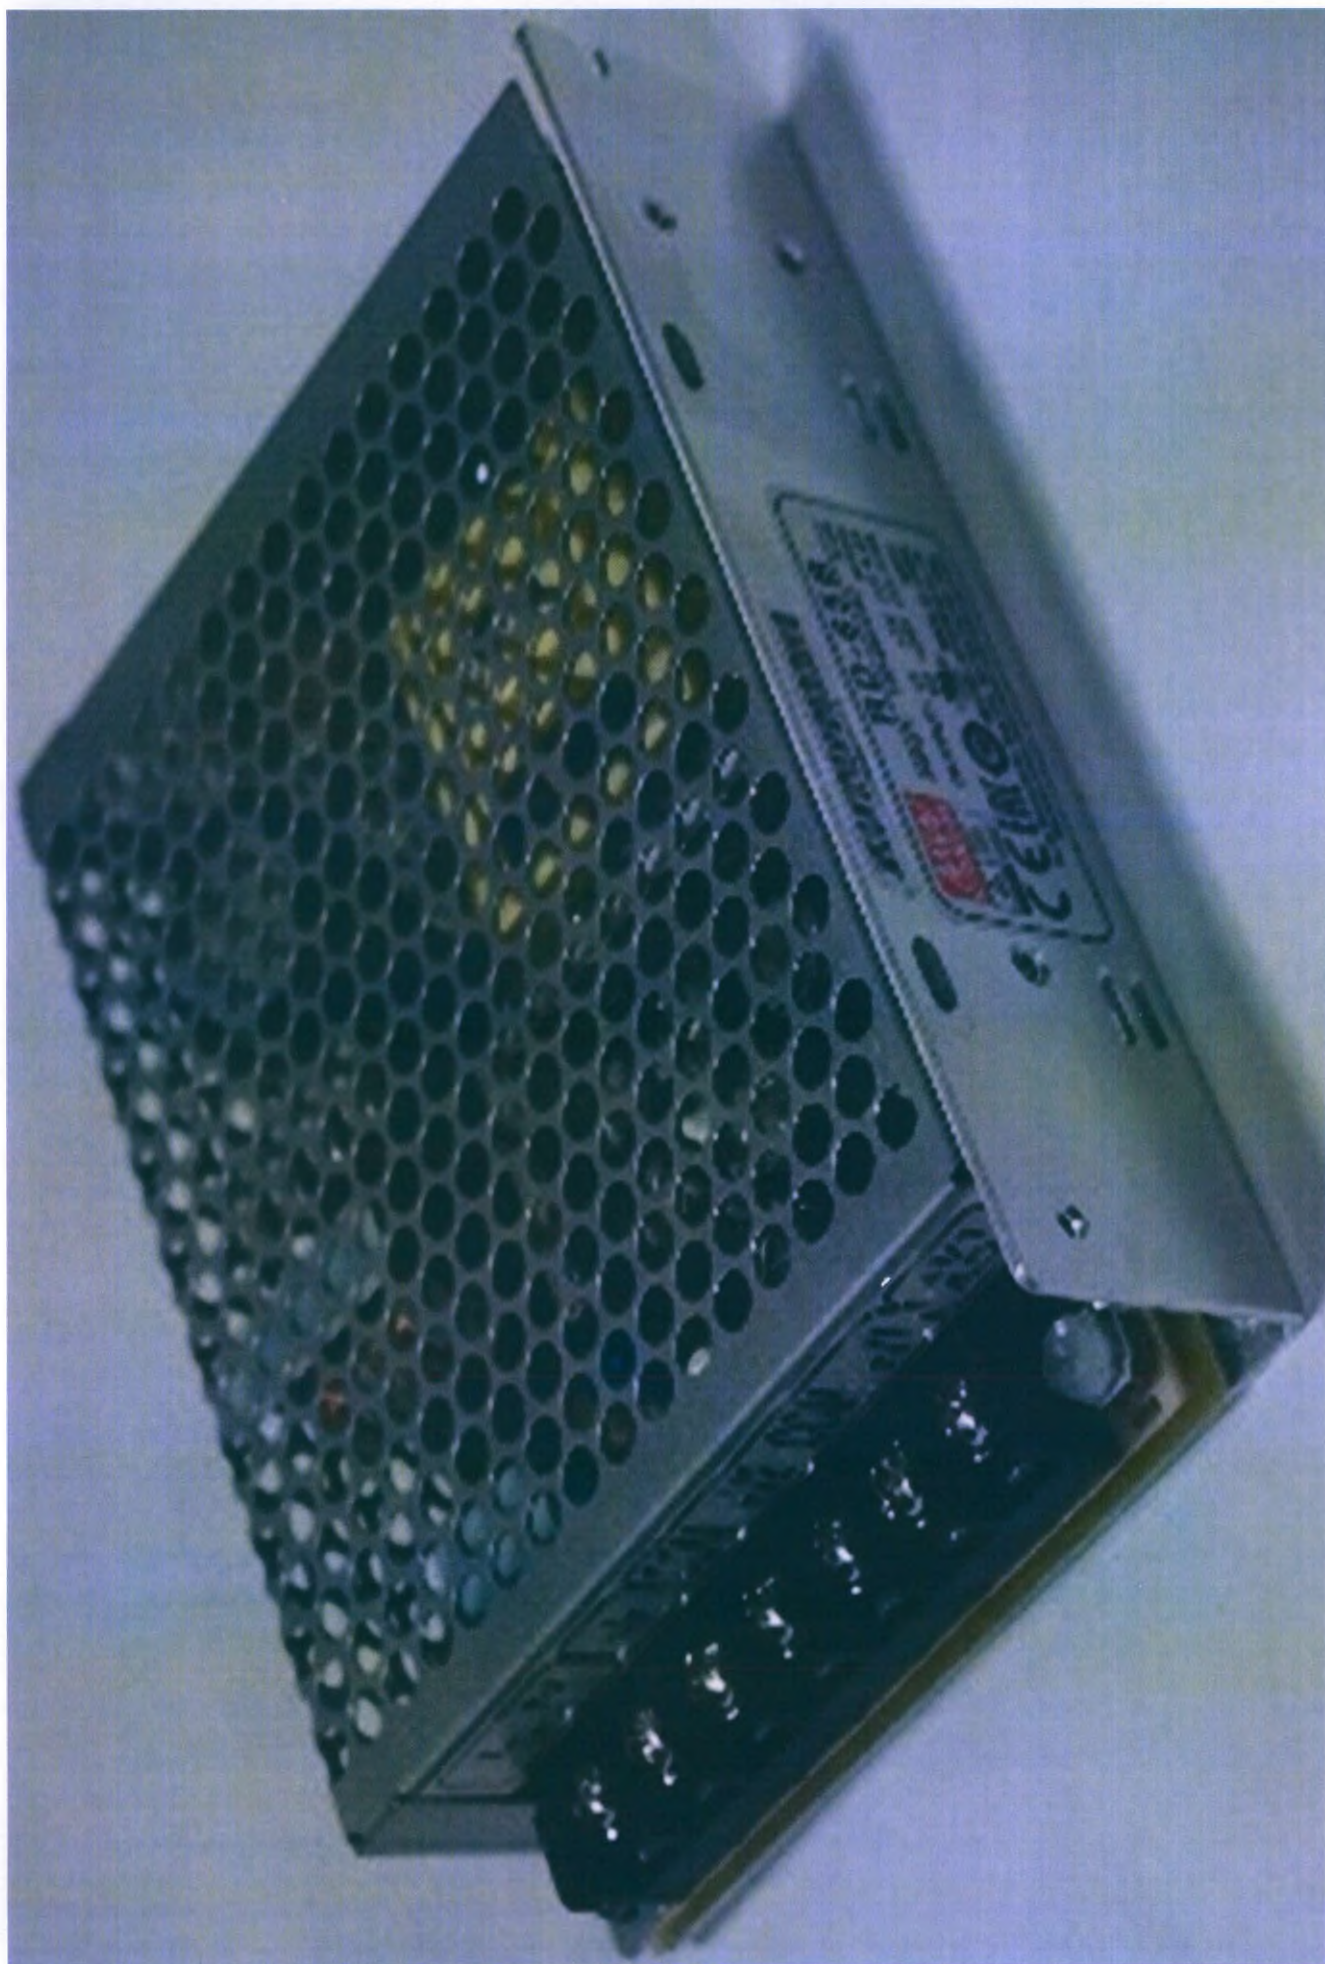


Блок питания

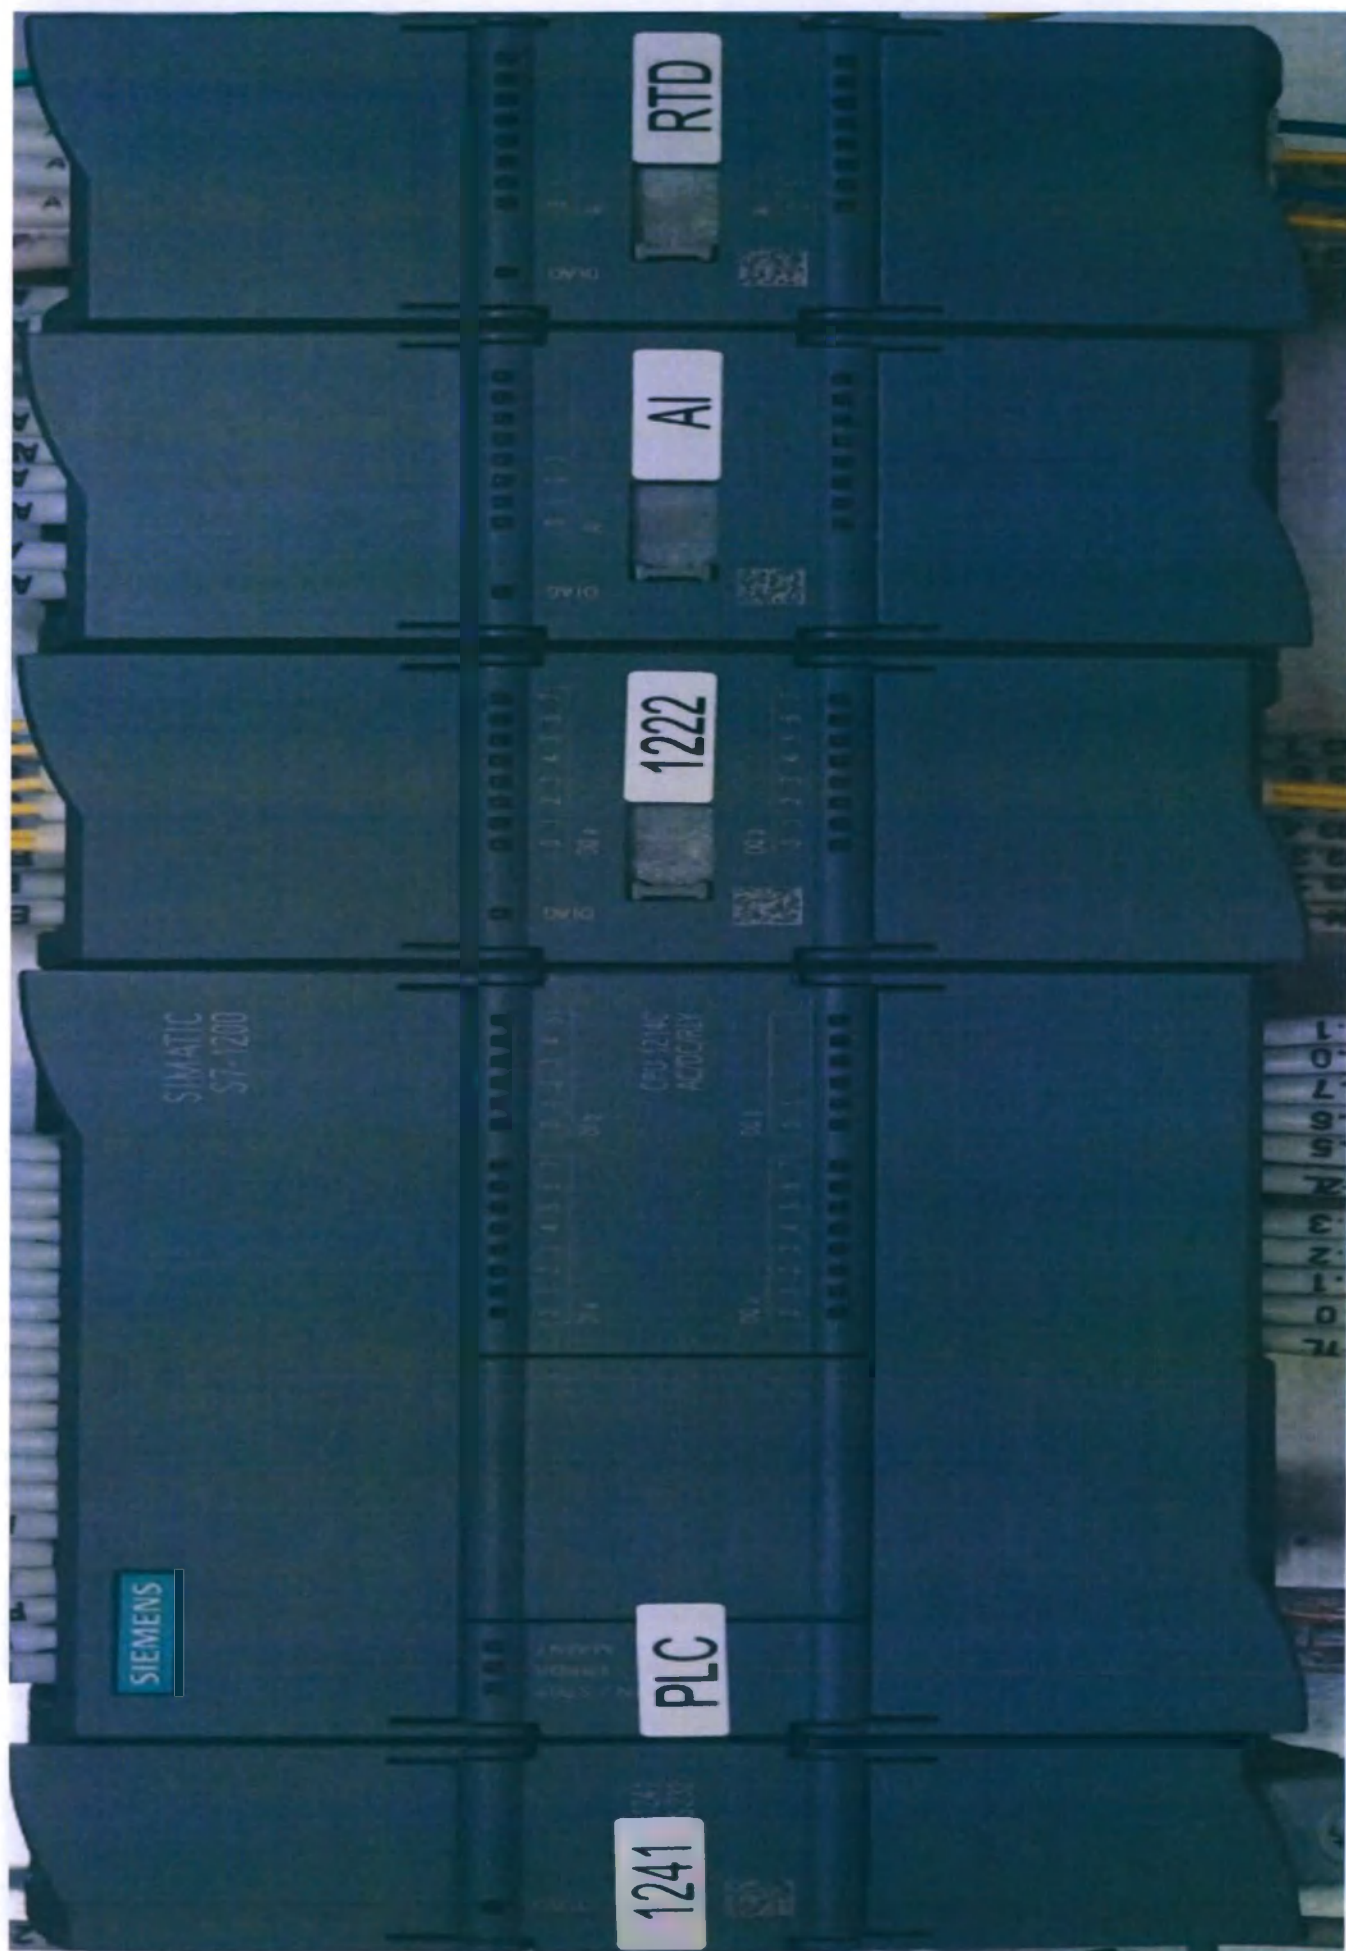

Блок процессорный

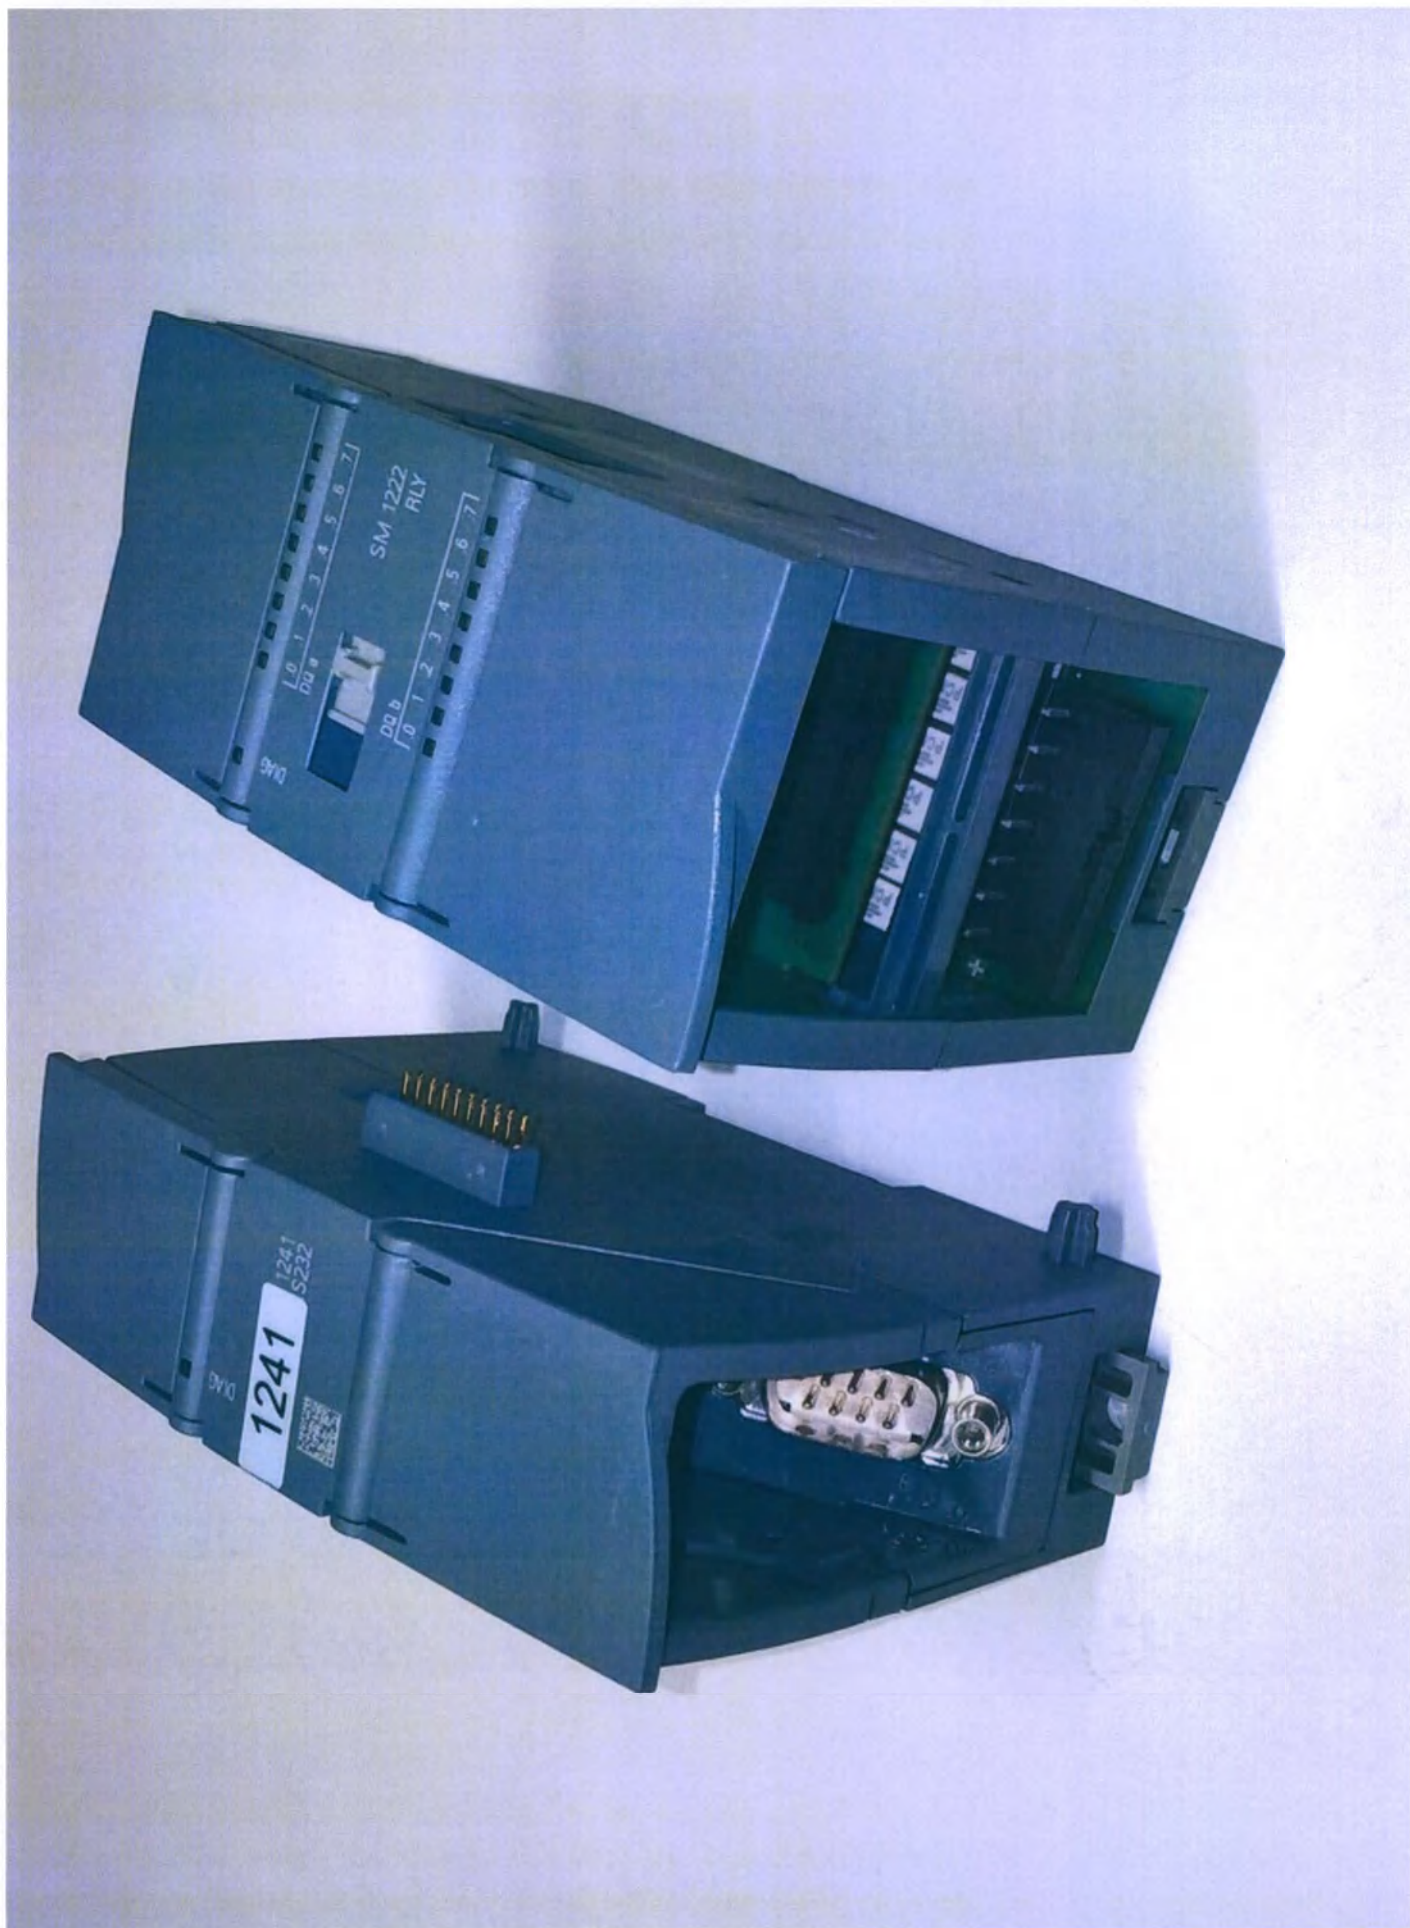

Блок расширения контроллера

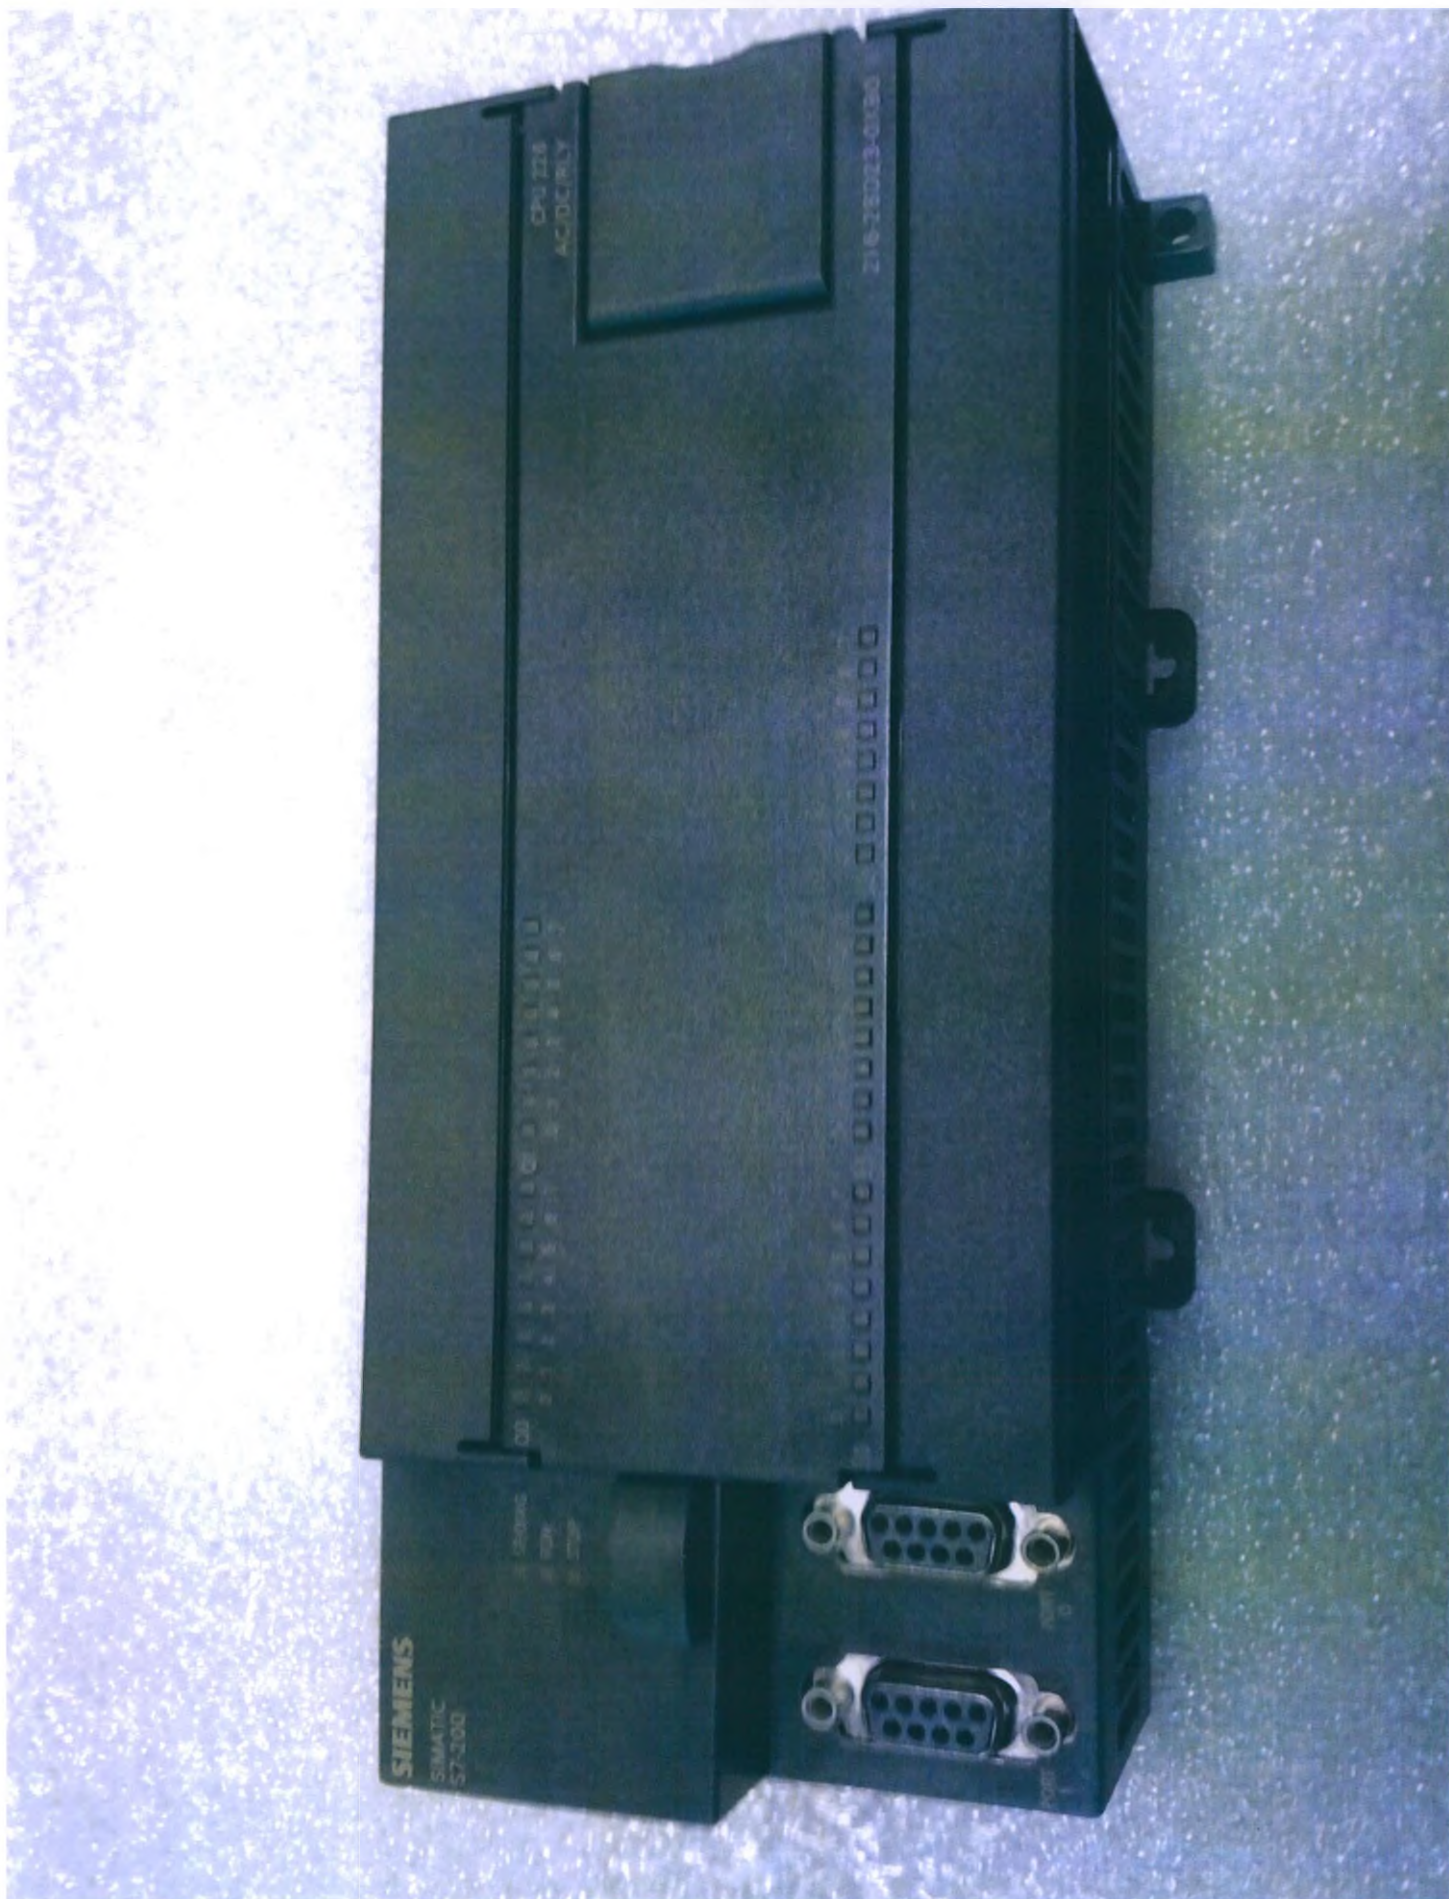

Блок управления




Быстръемные соединения




Вентили запорные



Вентилятор блока управления

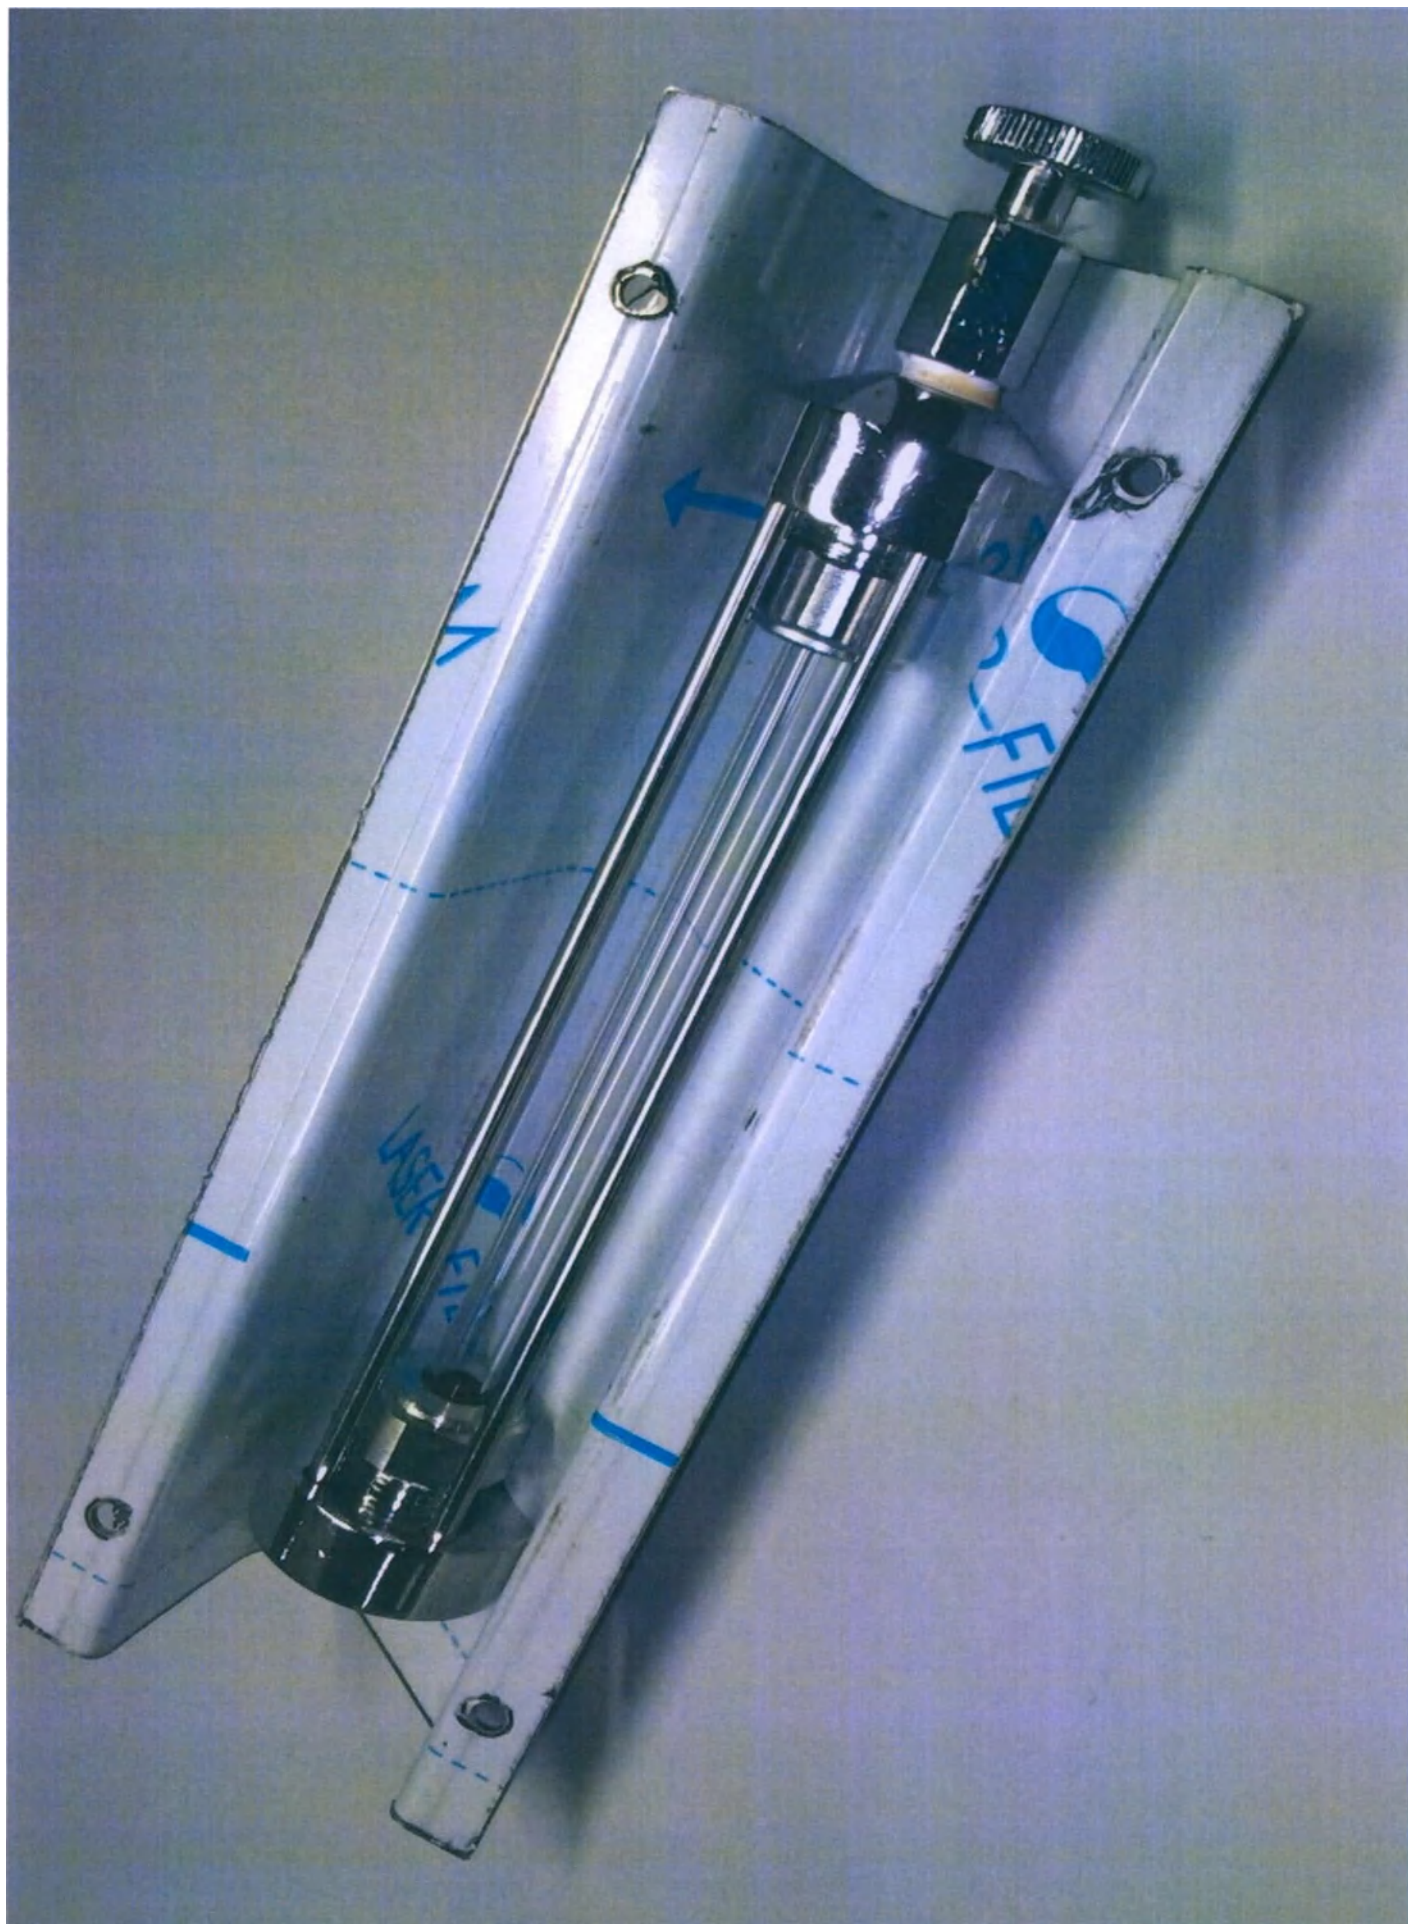

Водомерная колонка

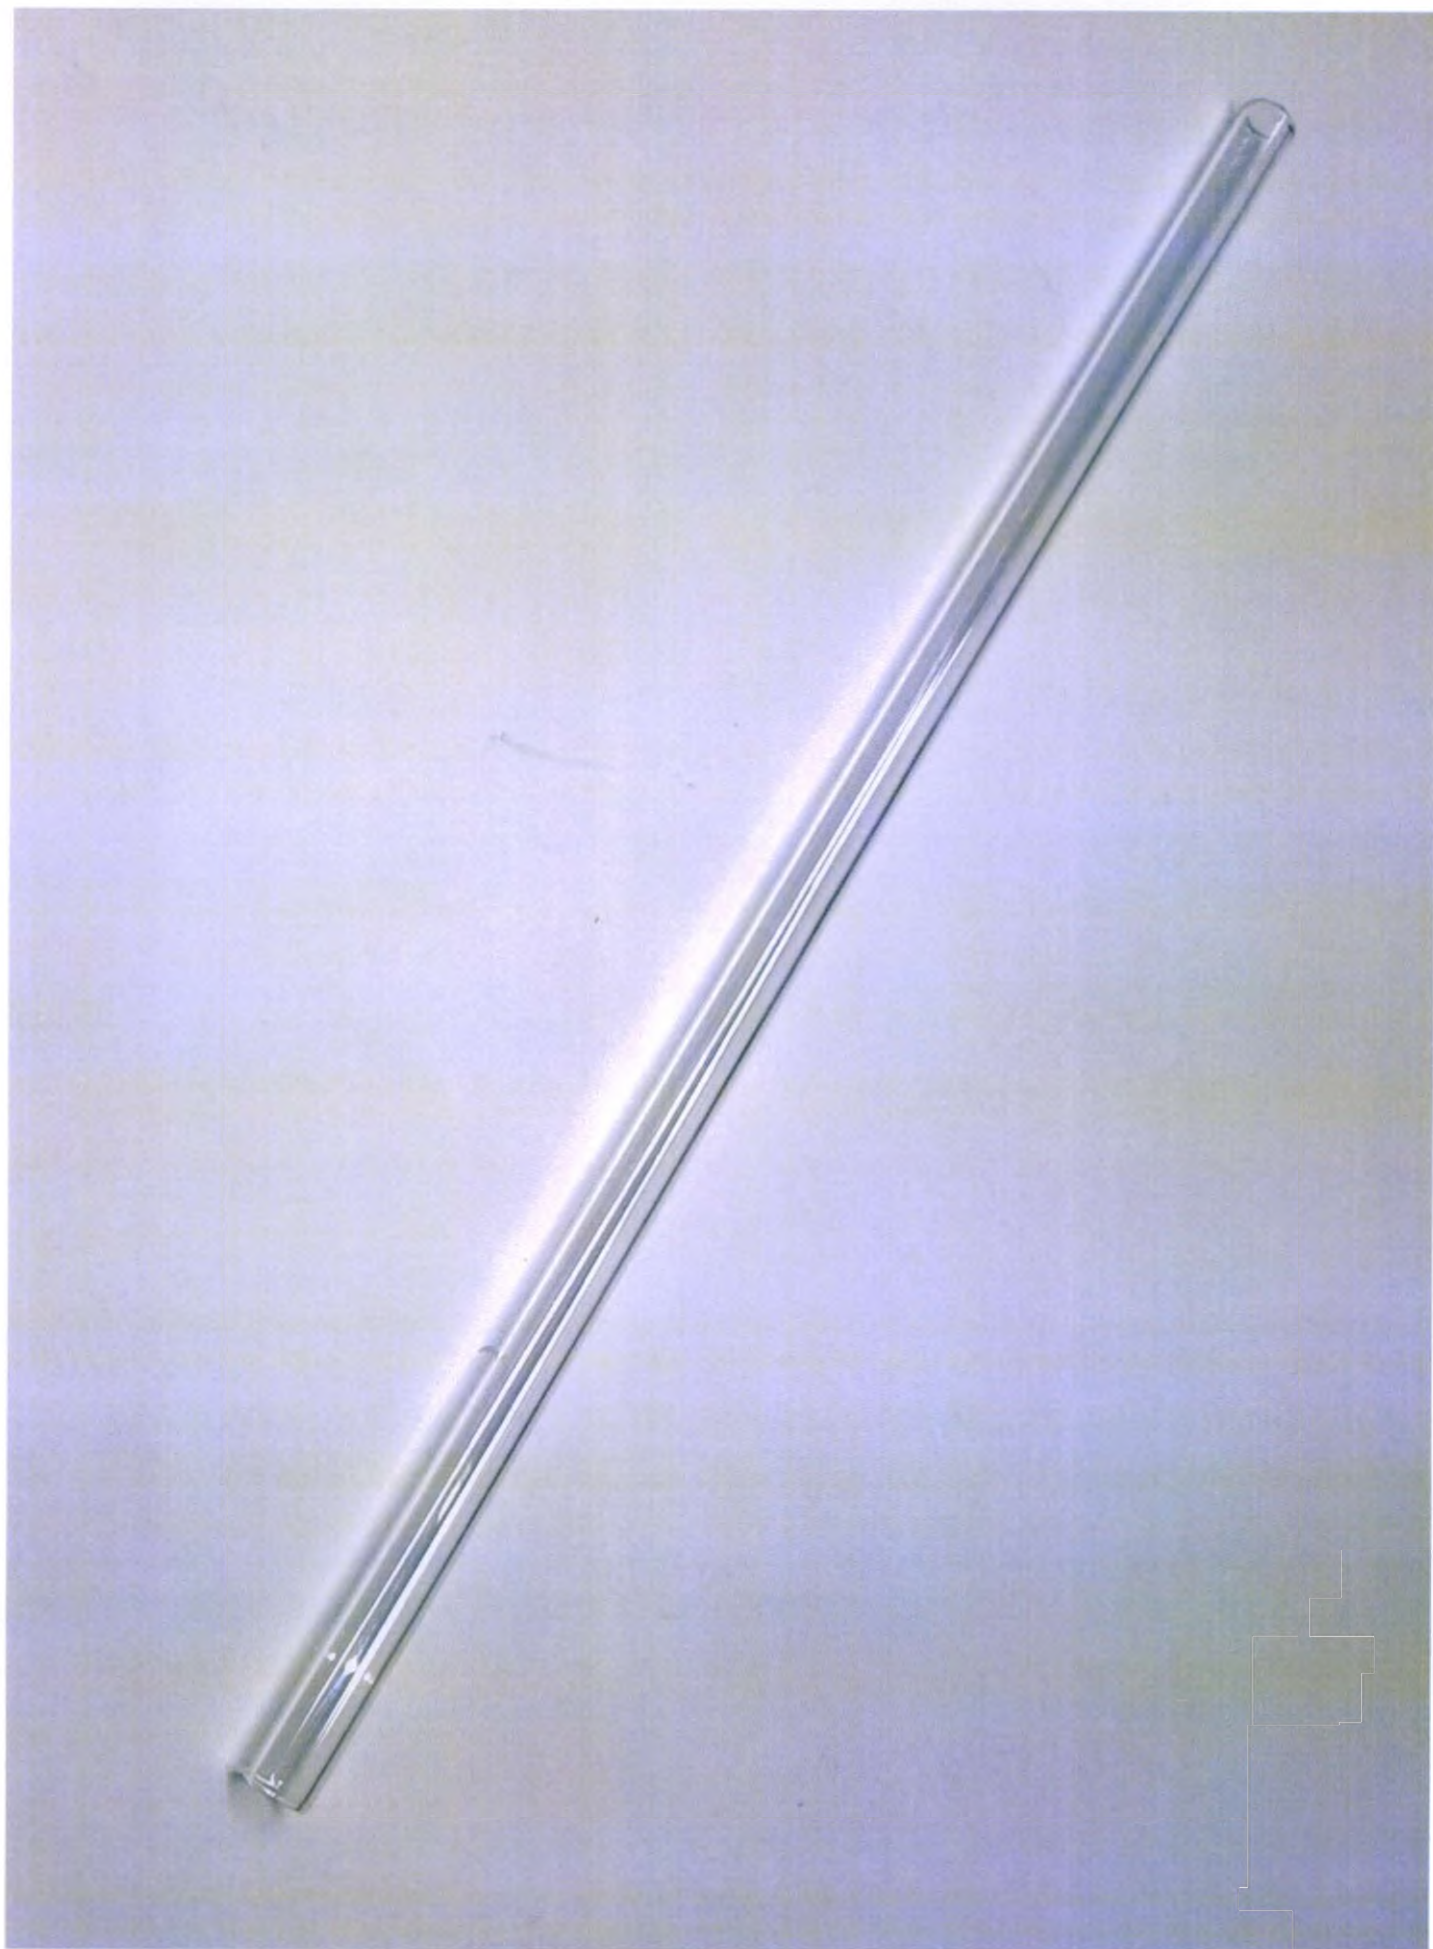

Водомерное стекло




Вставка в камеру большая, маленькая



Выключатель концевой



Выключатель питания

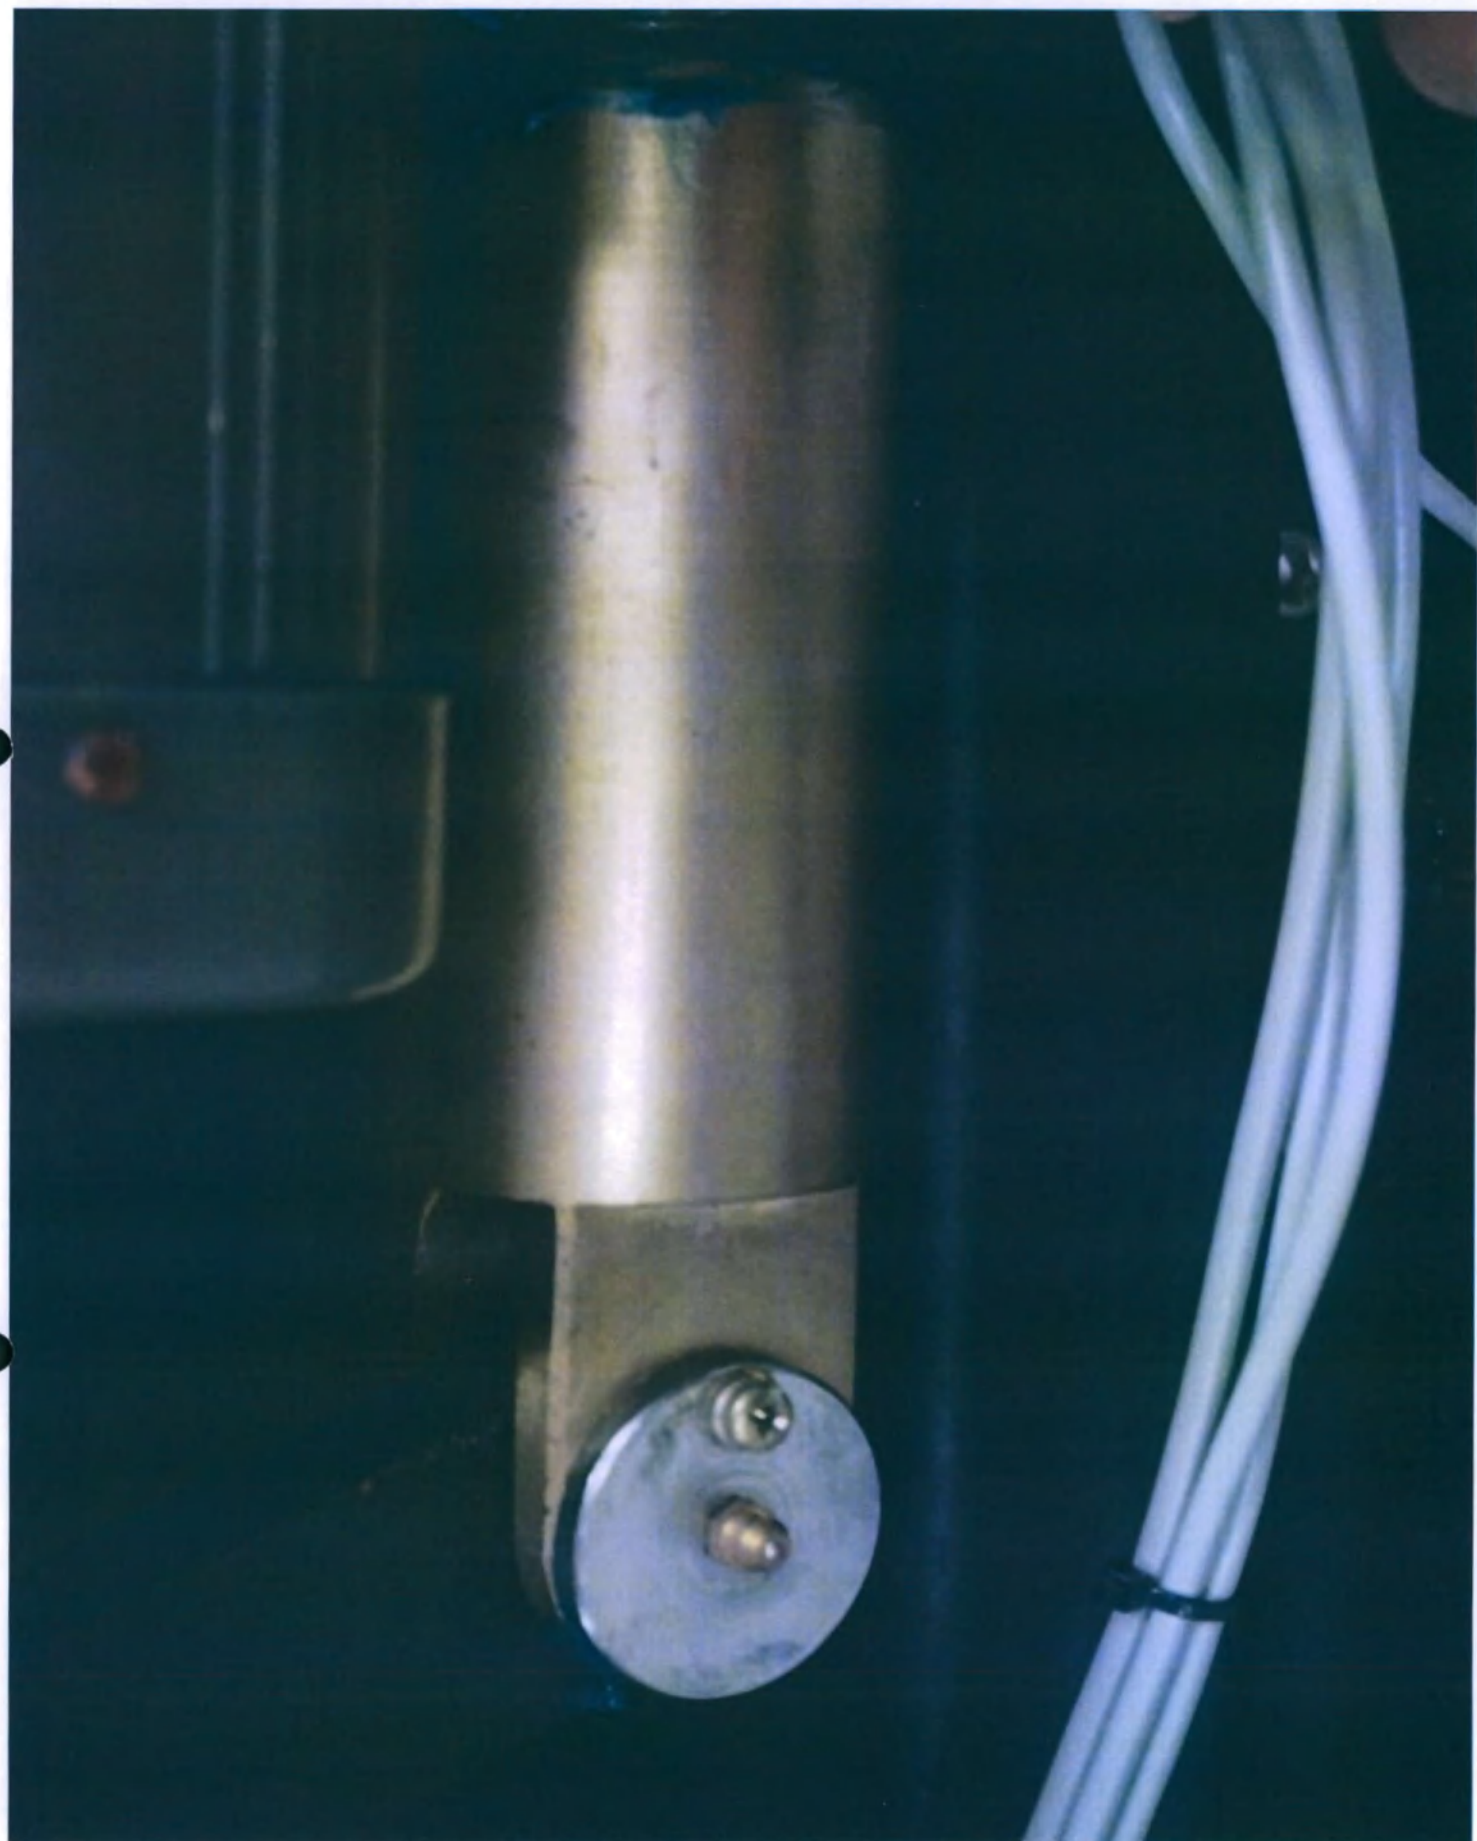

Гайка привода двери




Датчик давления



Датчик температуры




Датчик температуры выносной

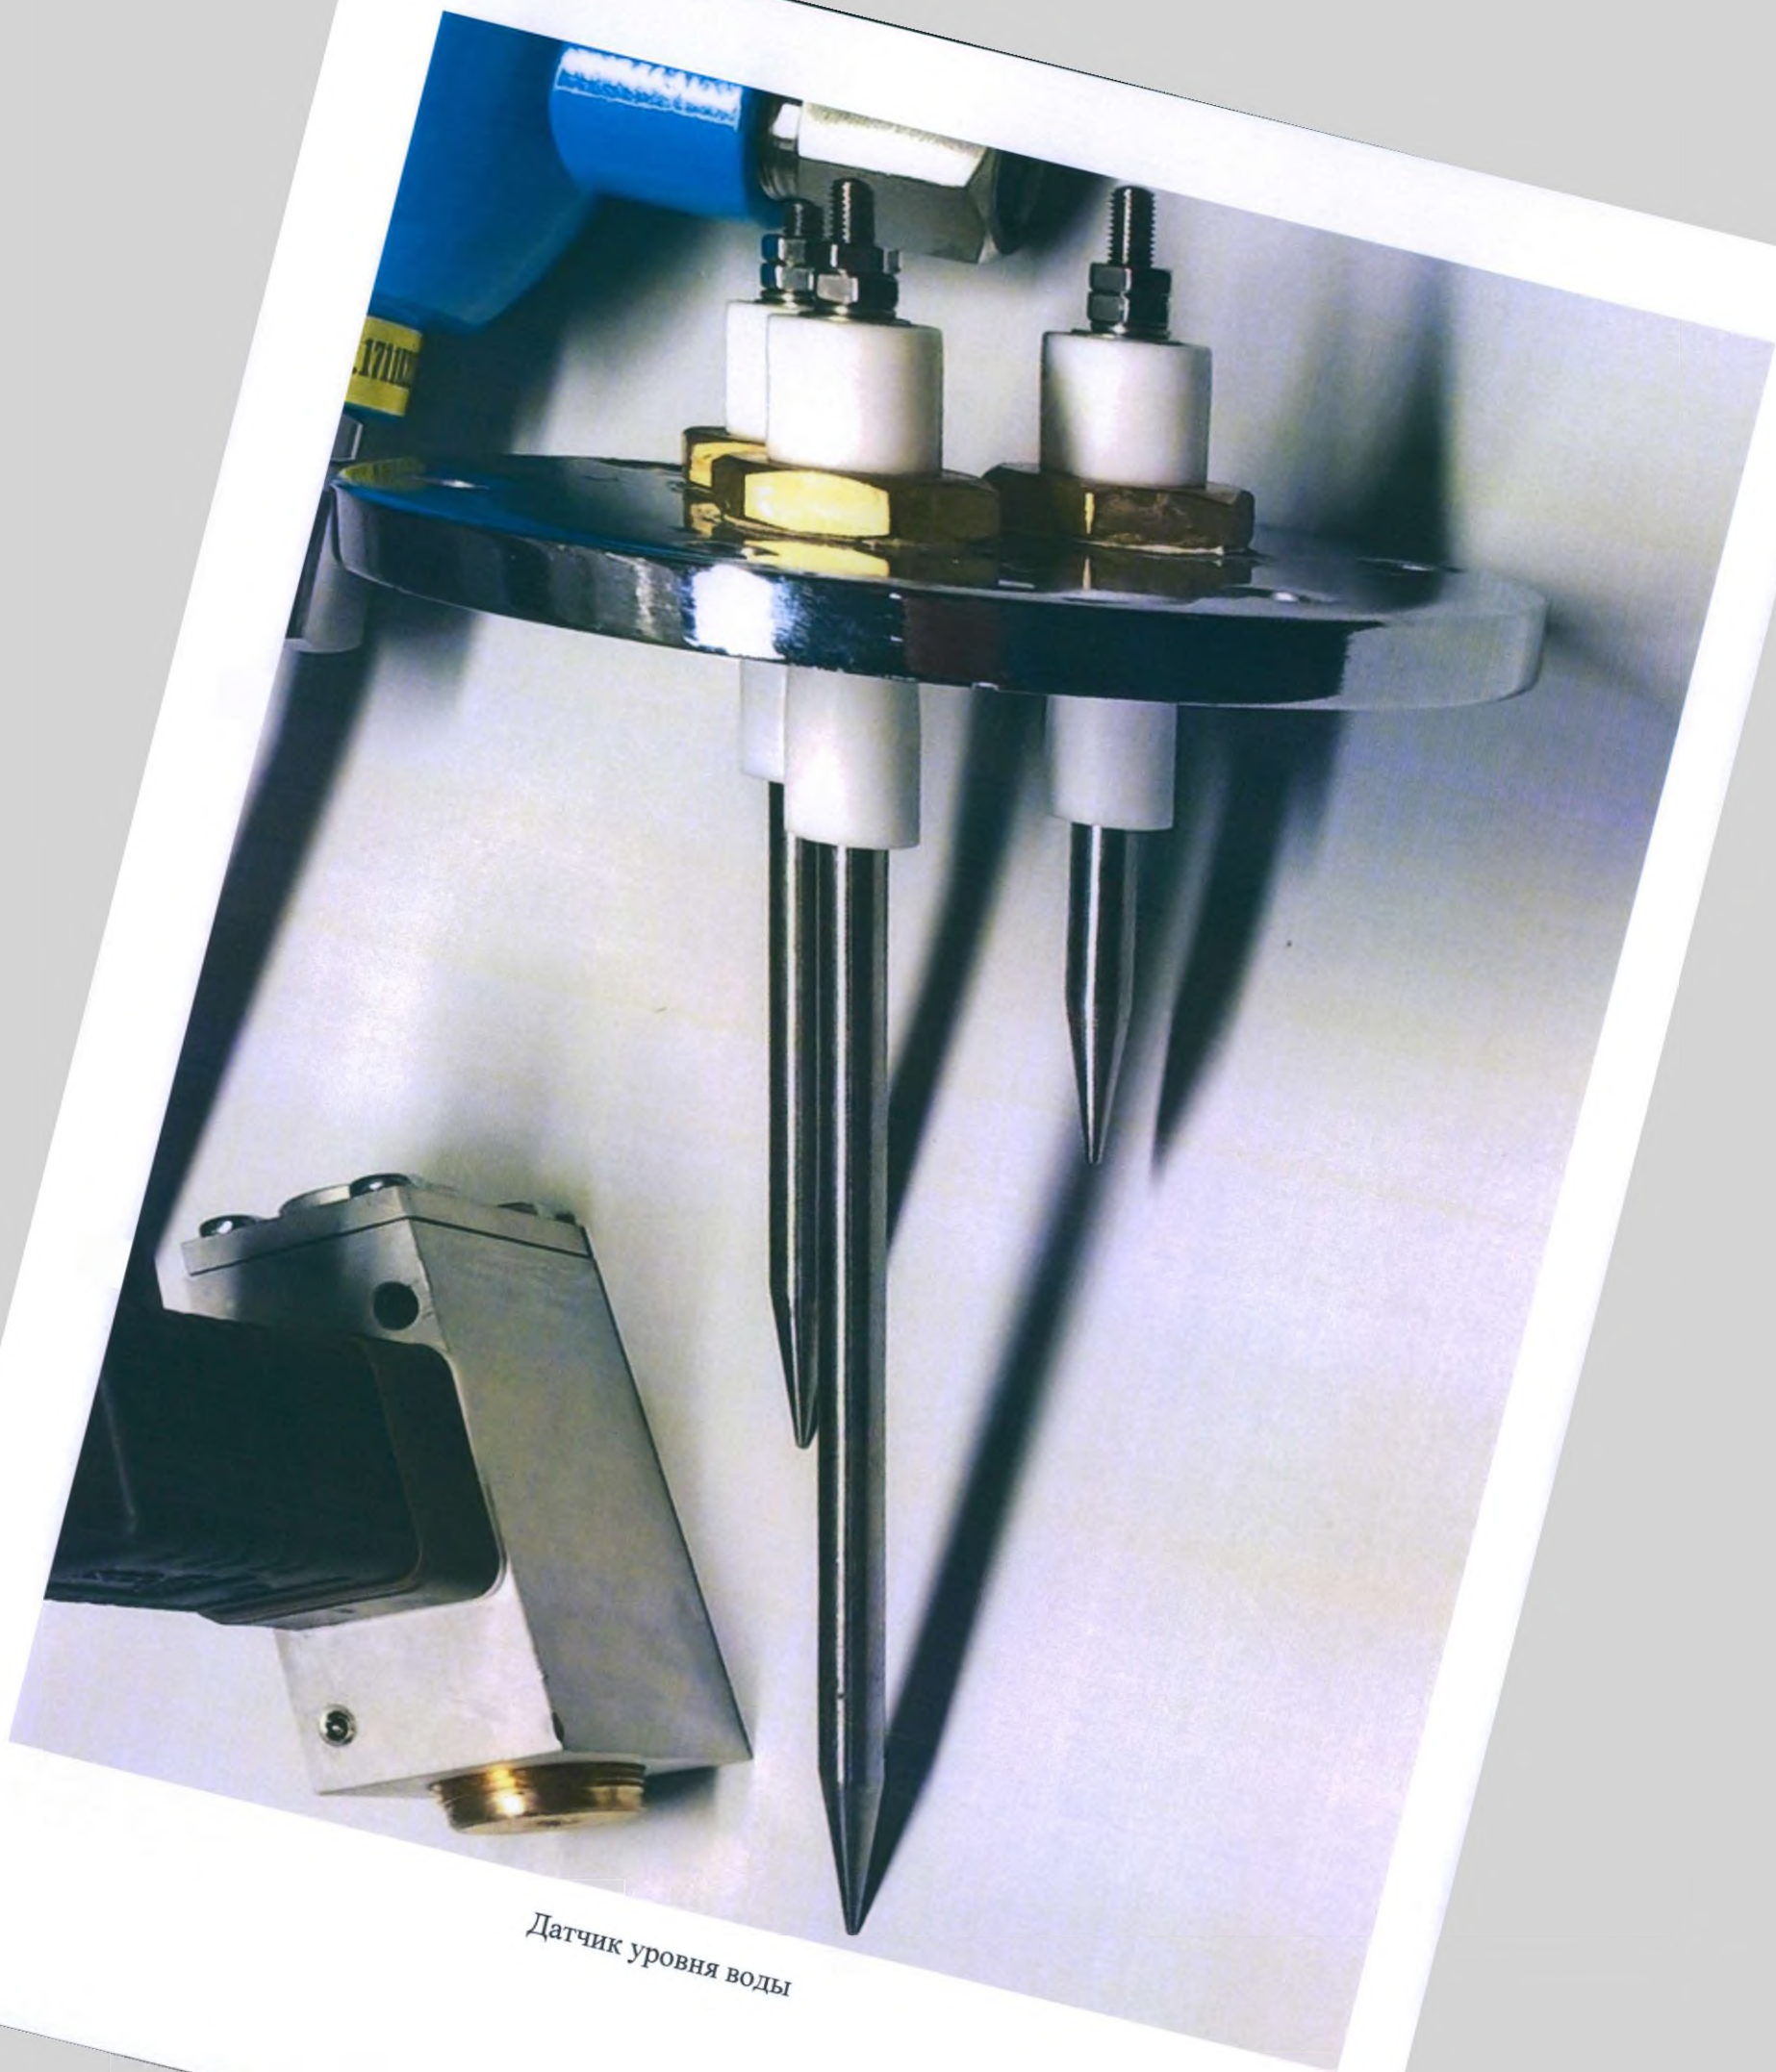


Датчик уровня воды




Дверная защелка

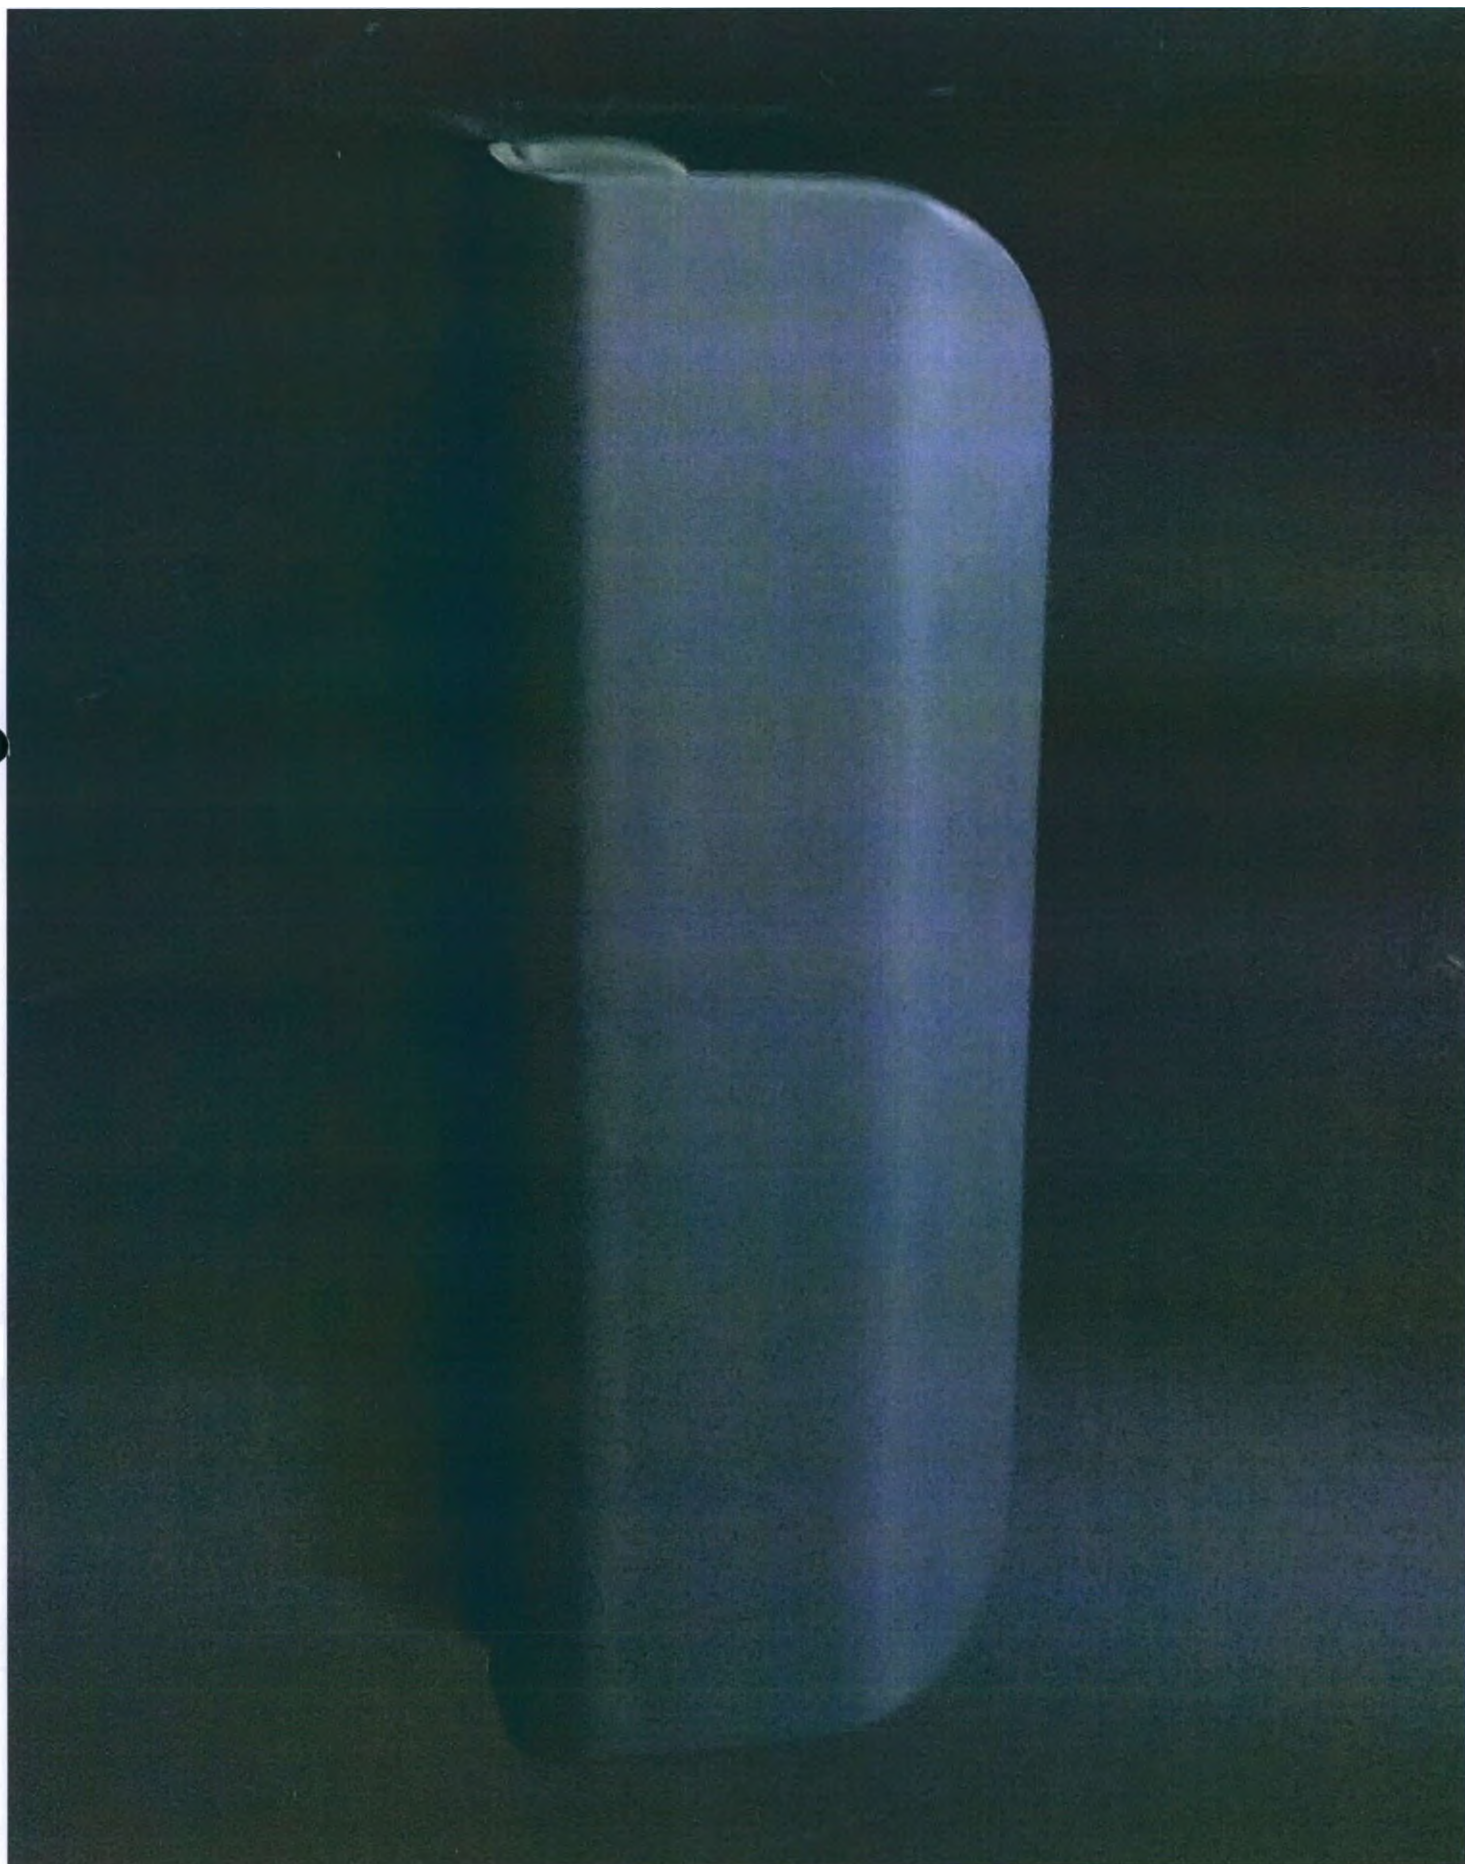

Дверная ручка

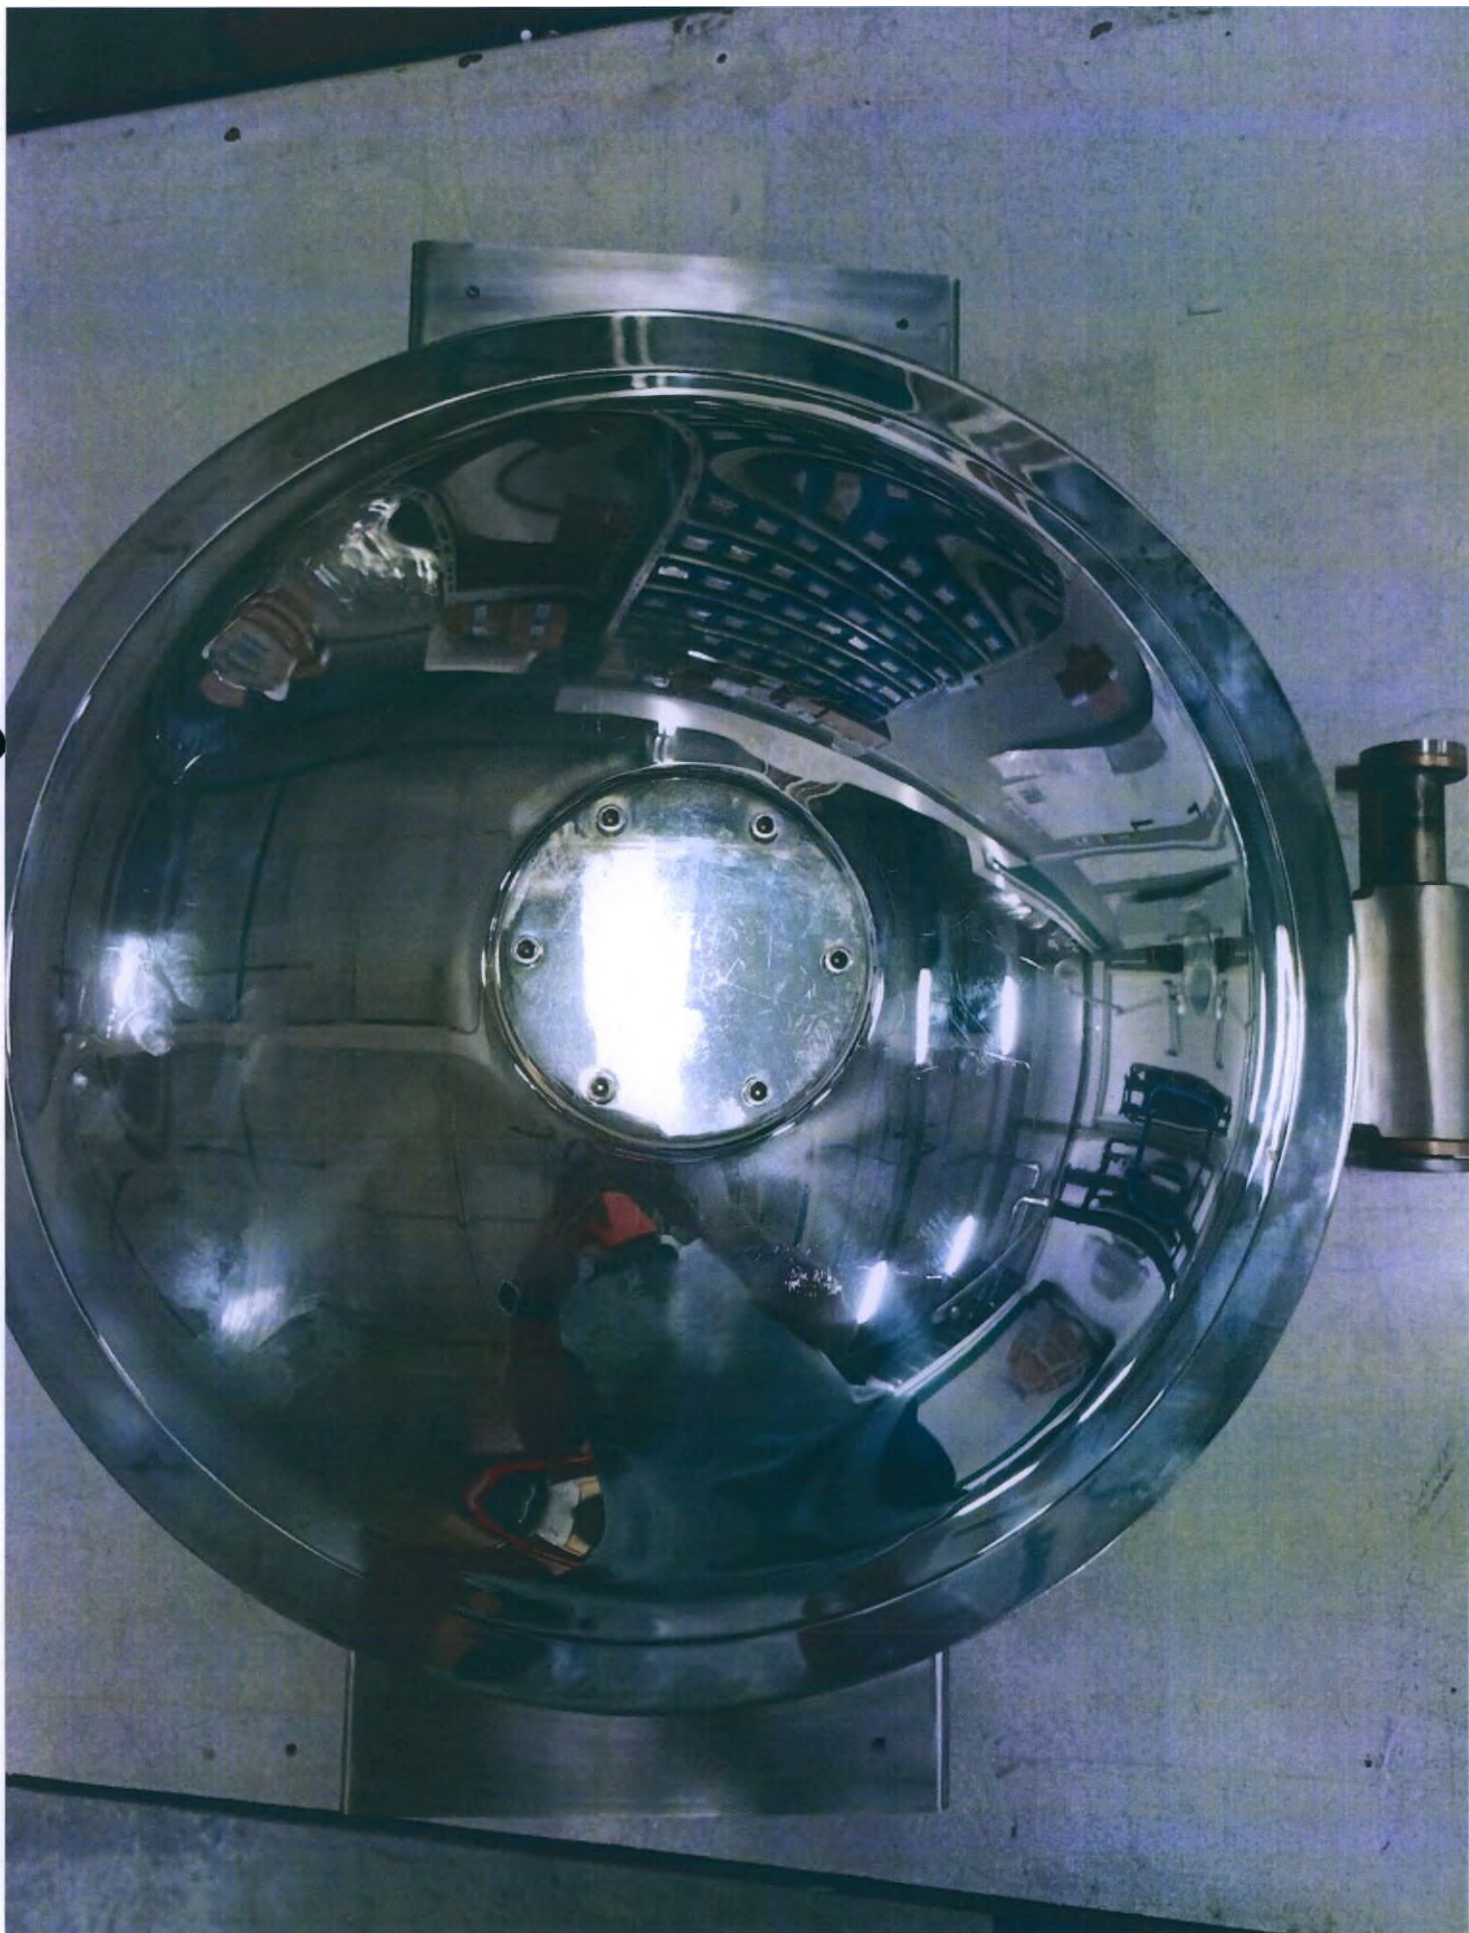


Дверь стерилизационной камеры (для исполнения DGM-100)

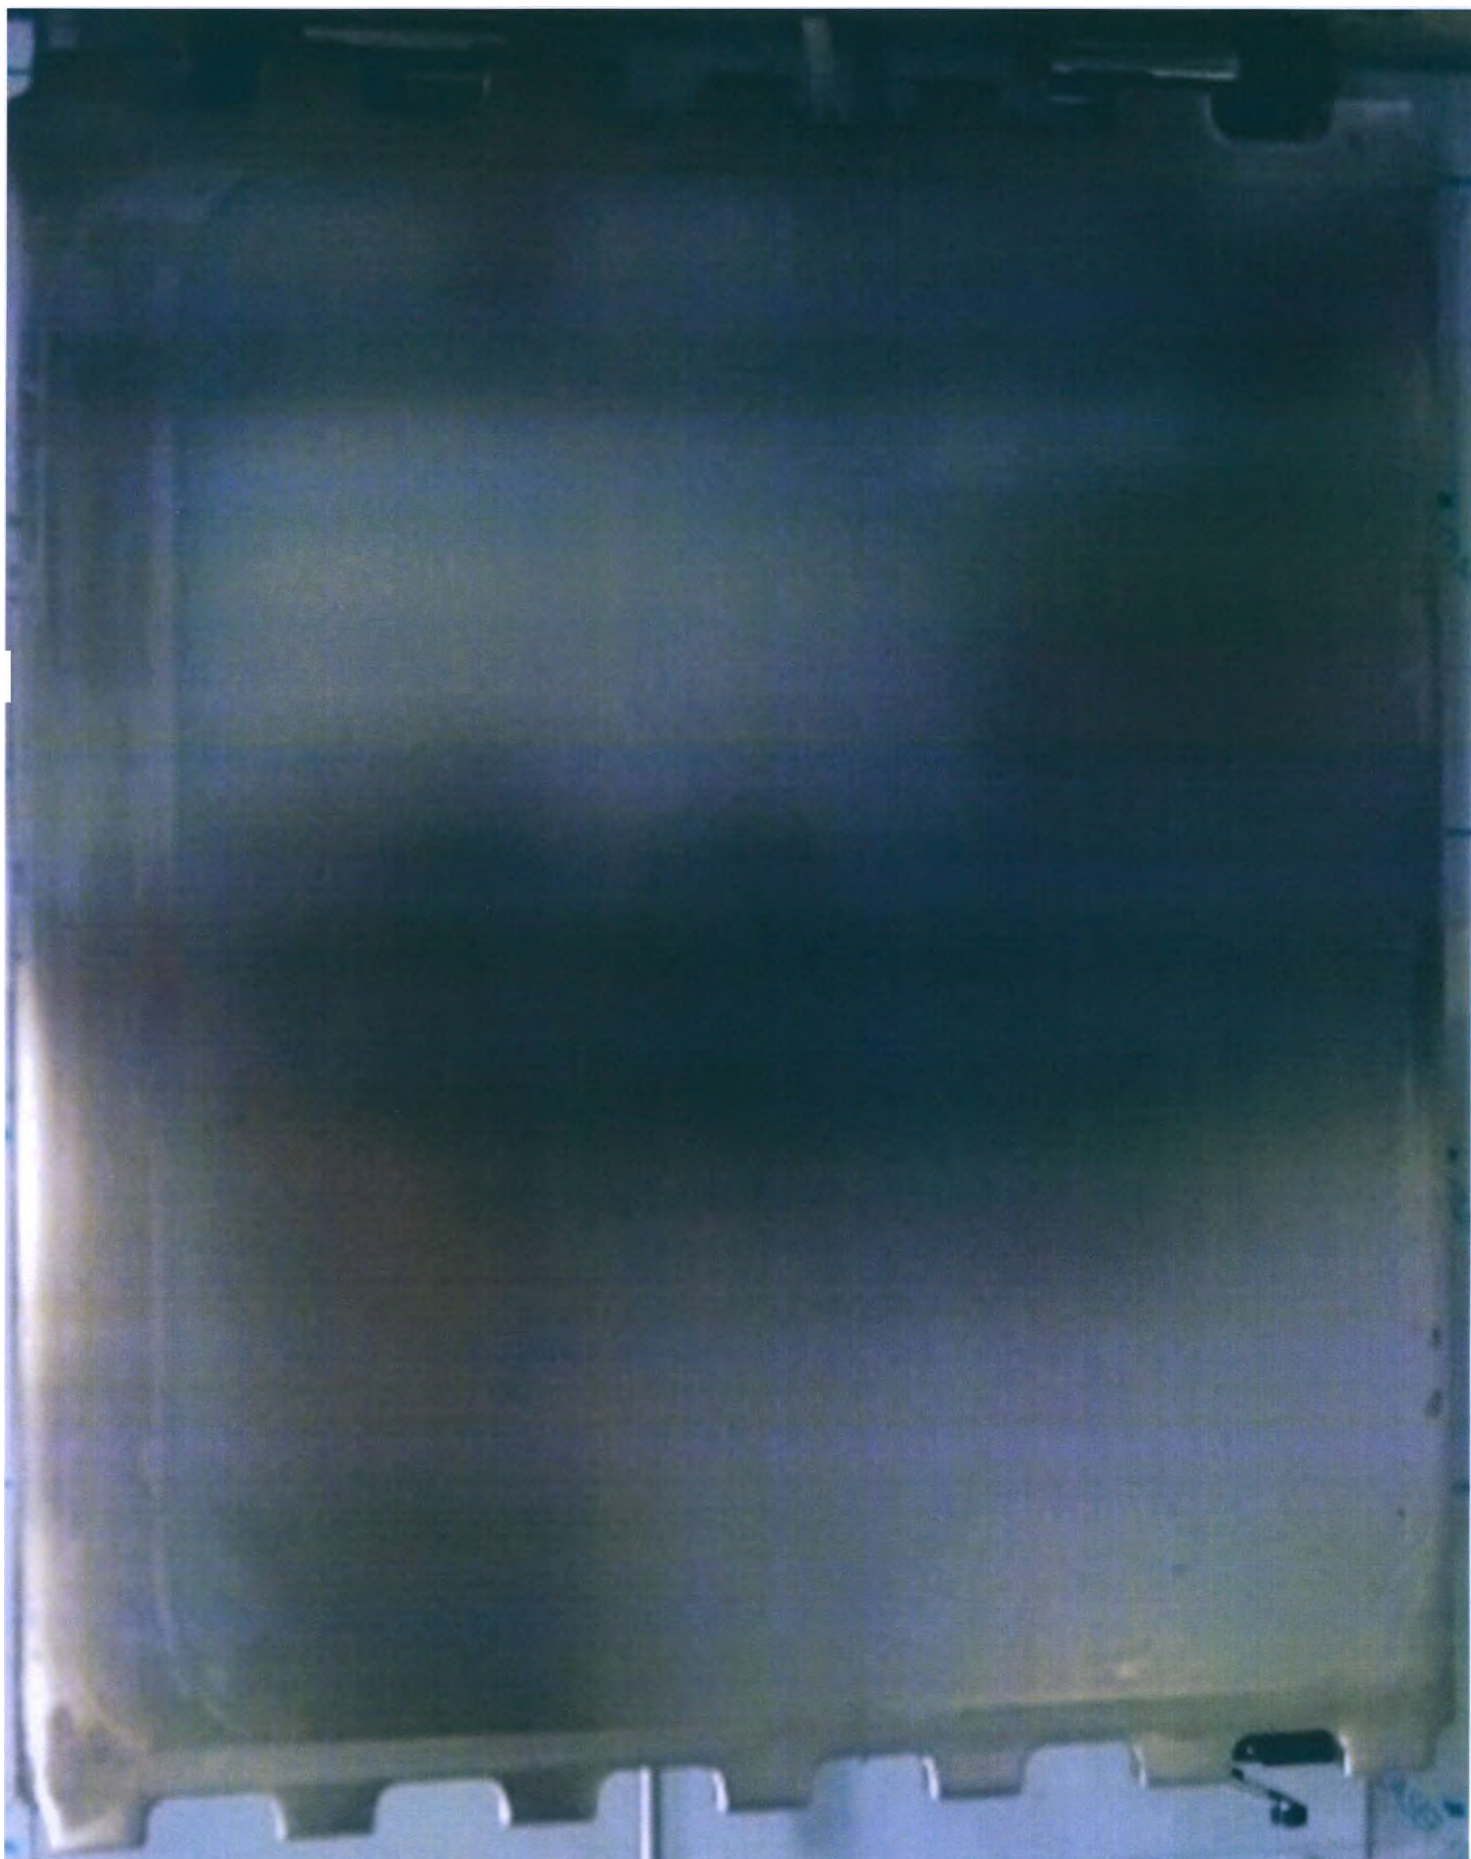

Дверь стерилизационной камеры (для исполнений DGM-130 – DGM-2000)



Двигатель привода механизма закрытия двери

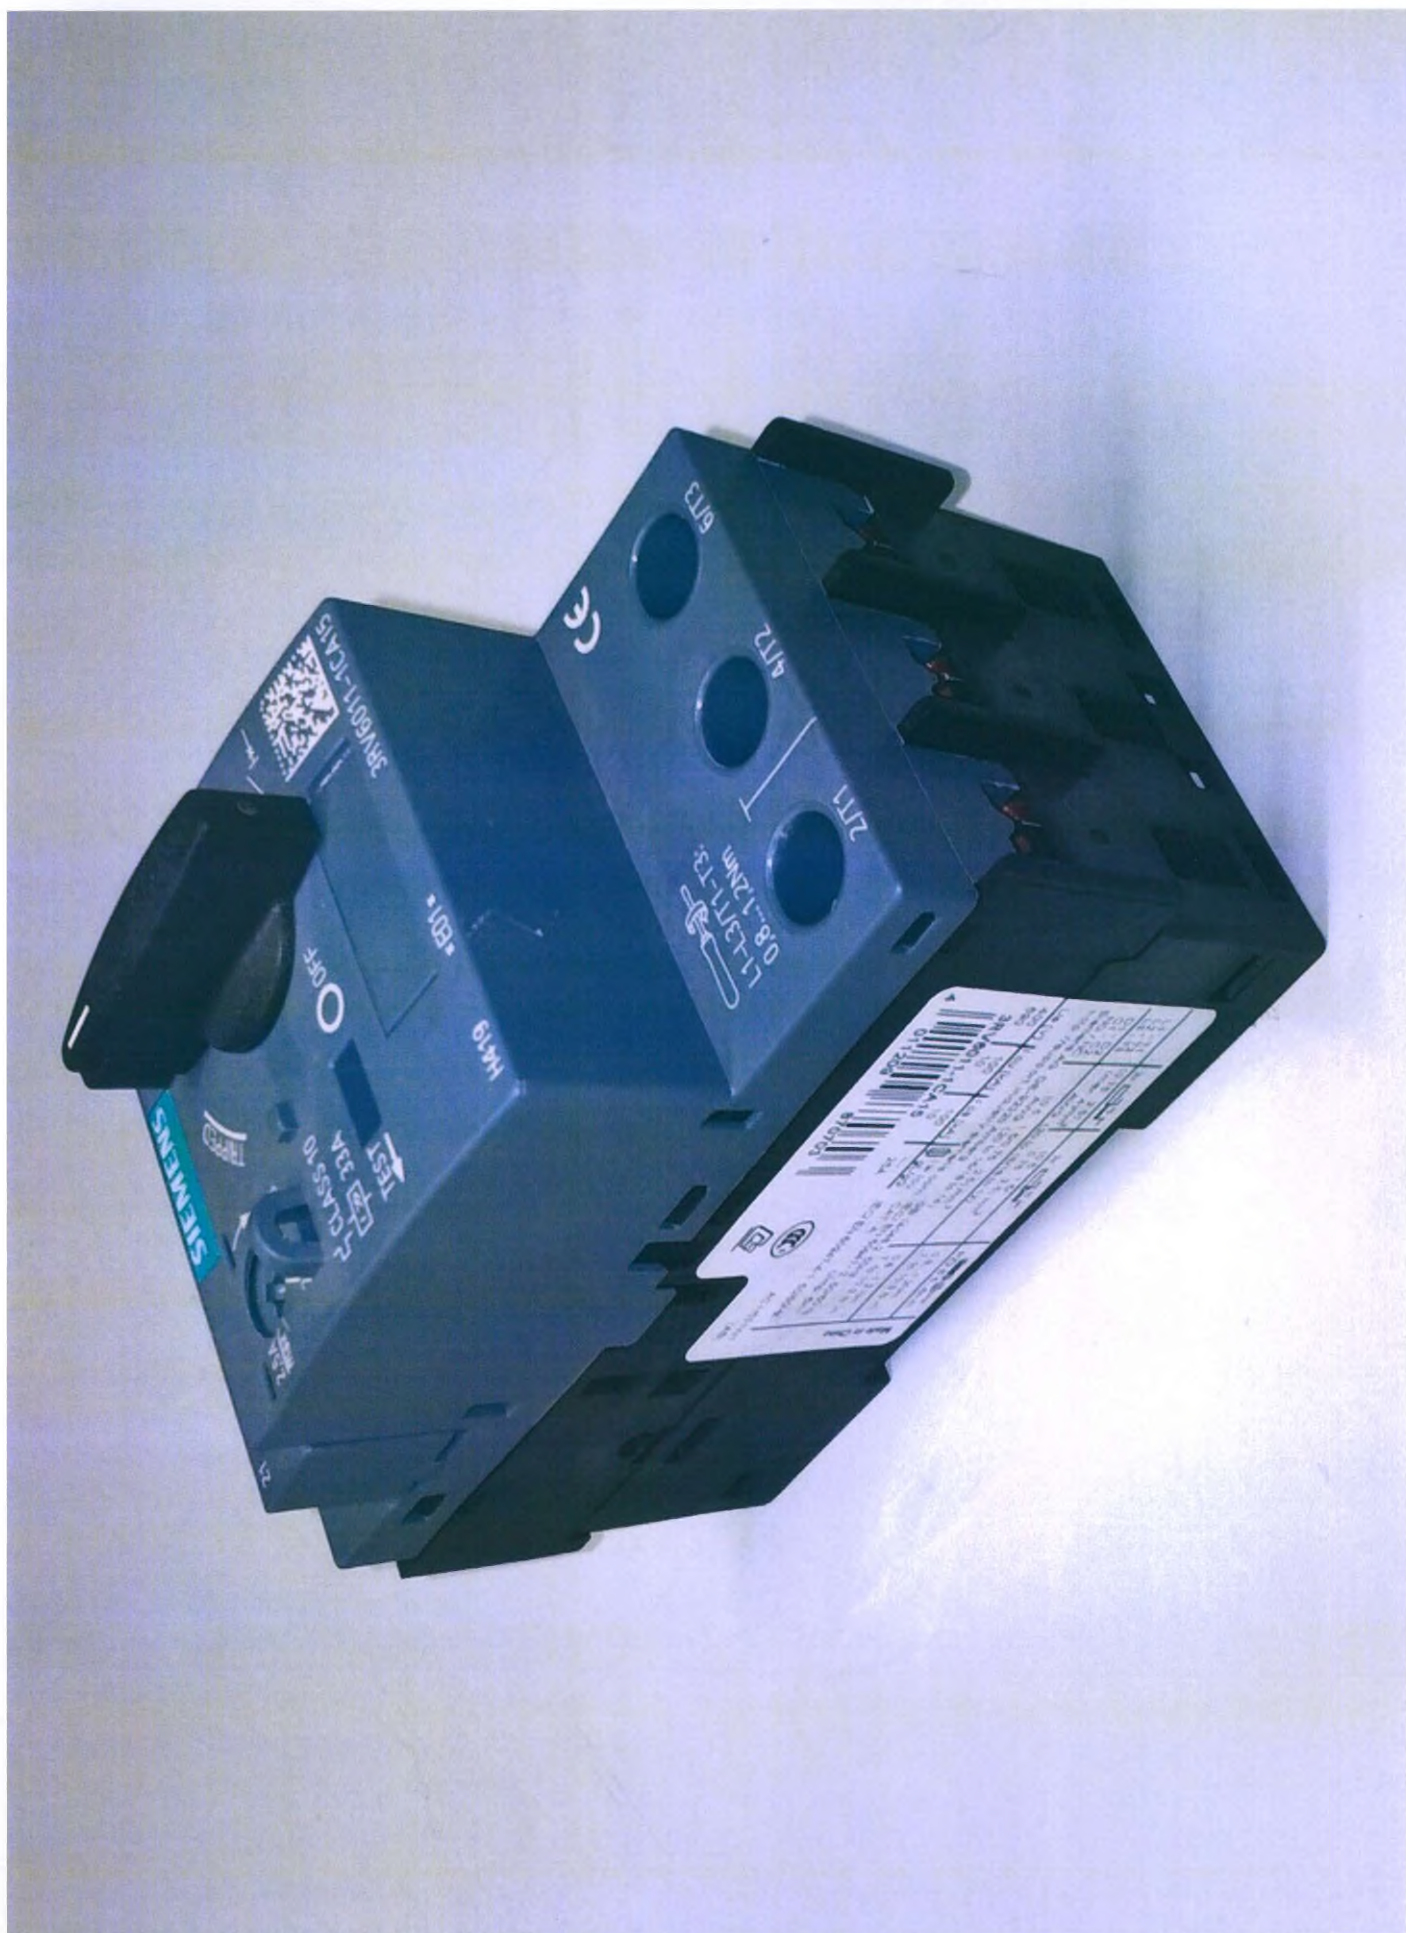

Детектор перегрева



Заглушка




Зажим для соединений типа “tri-clamp”




Камера стерилизационная (для исполнения DGM-100)



Камера стерилизационная (для исполнений DGM-130 – DGM-2000)

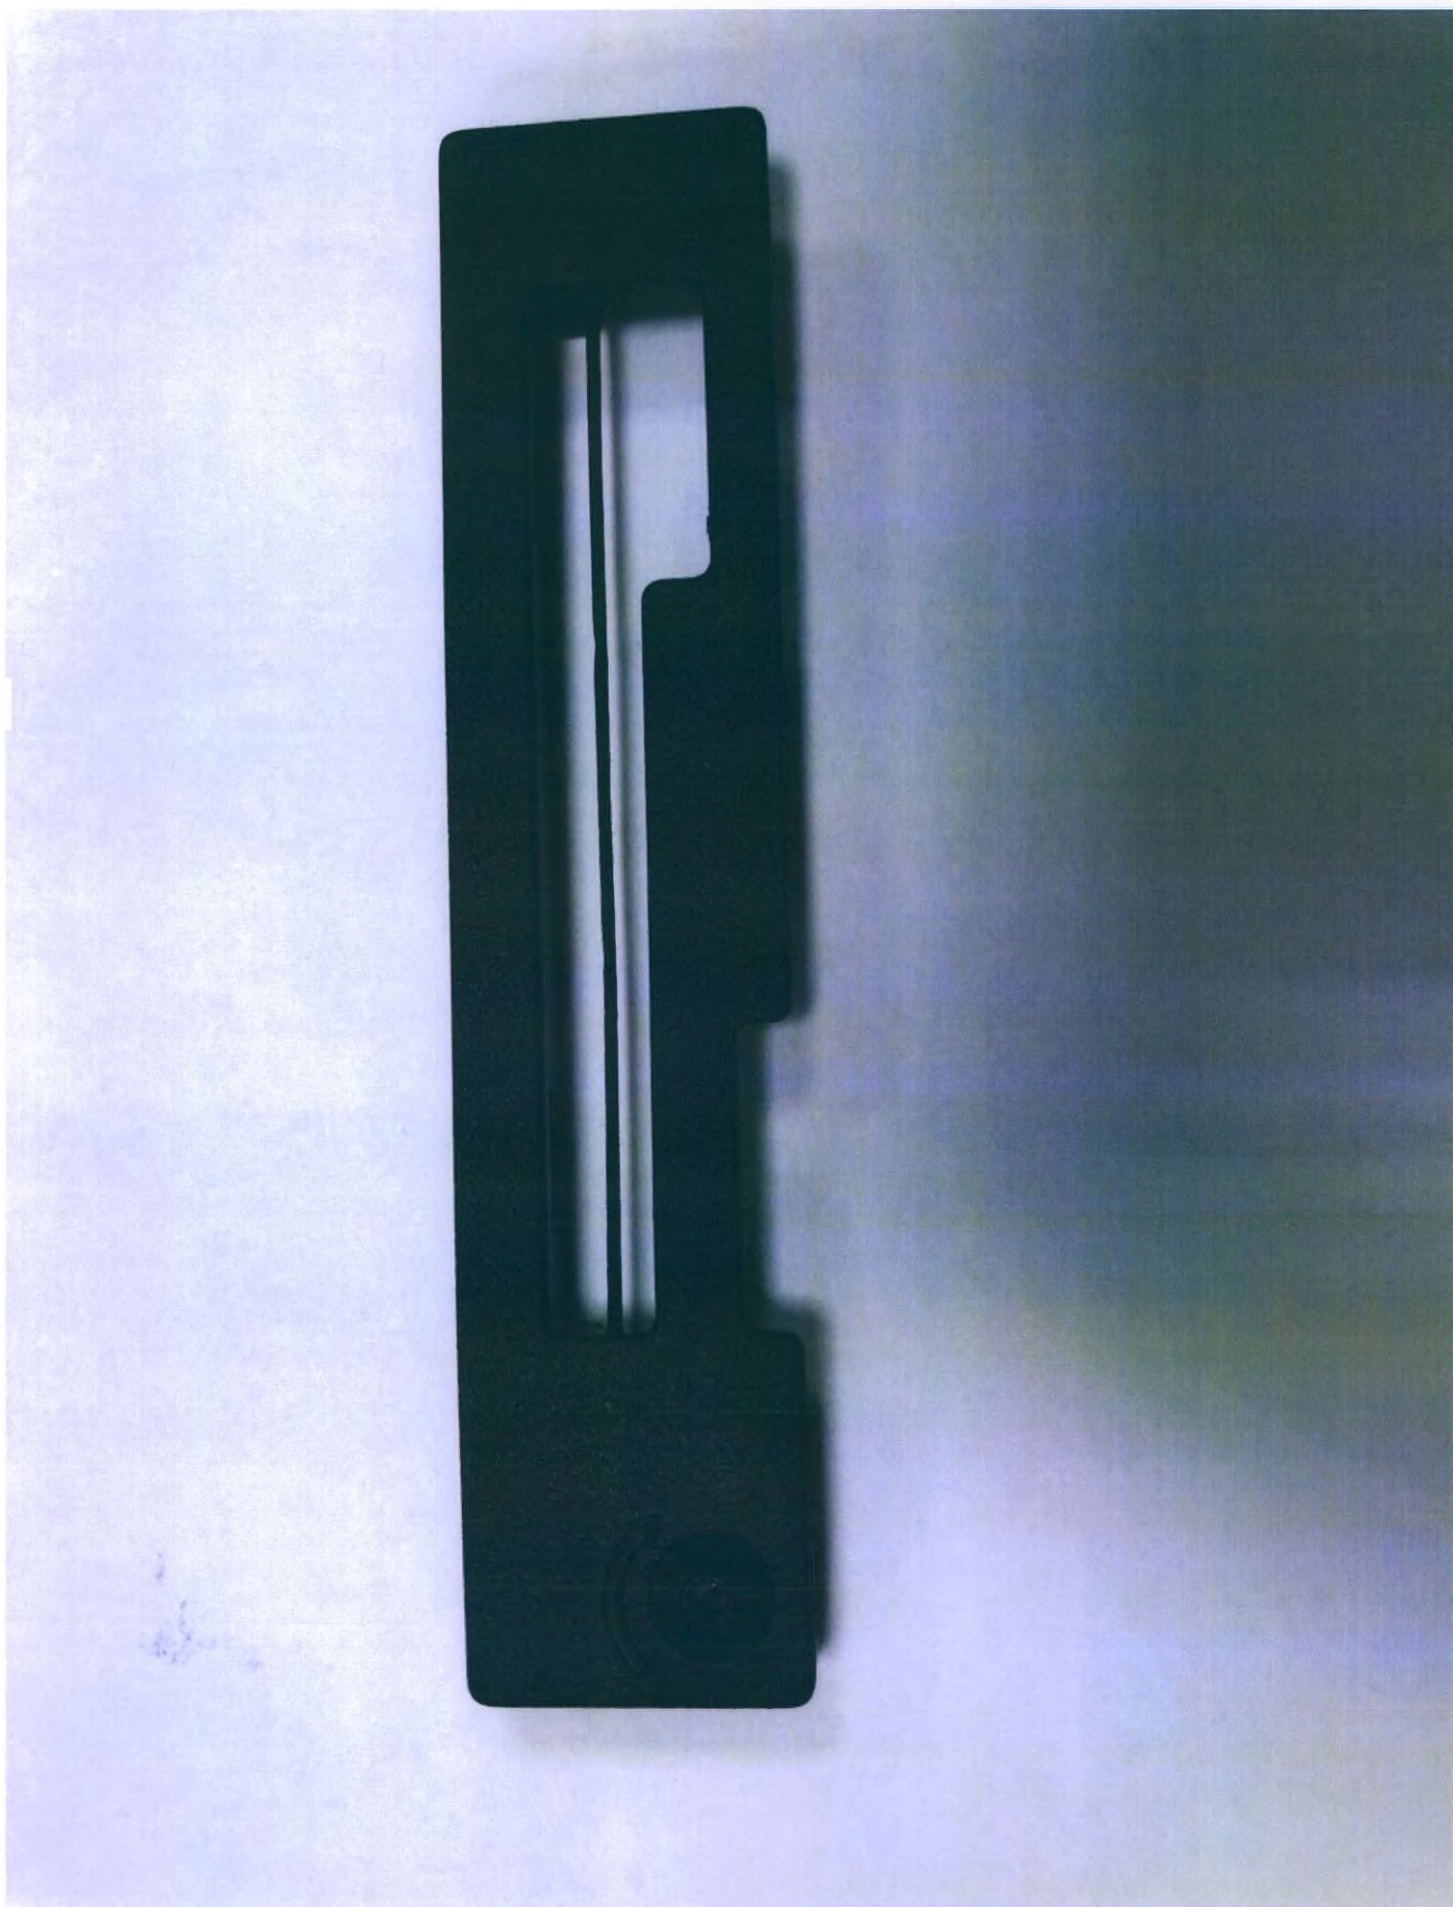

Картридж ленточный для принтера, встроенного

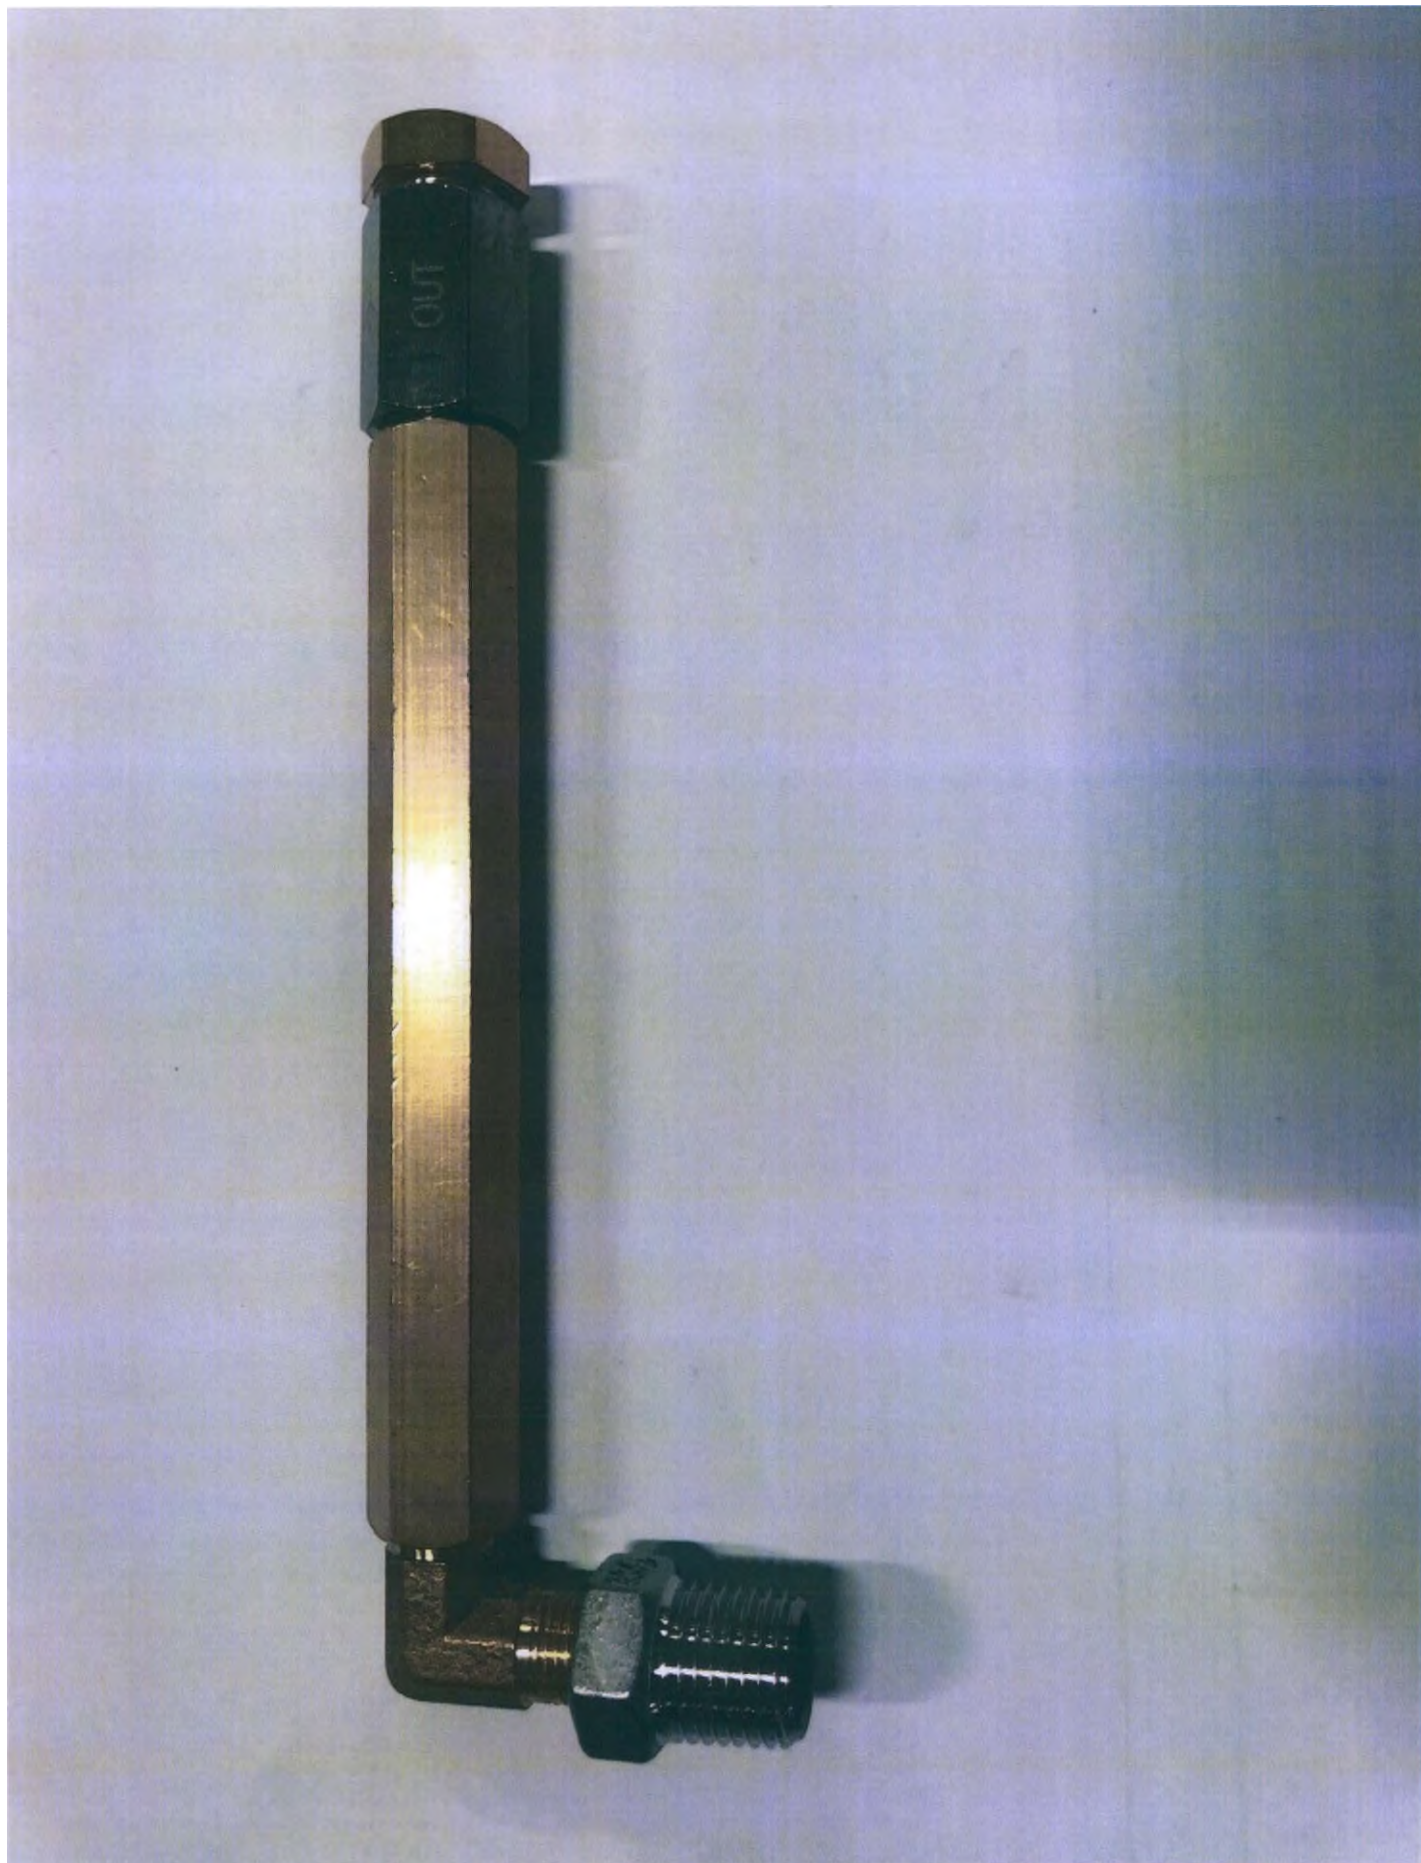


Клапан антикавитационный




Клапан обратный




Клапан предохранительный

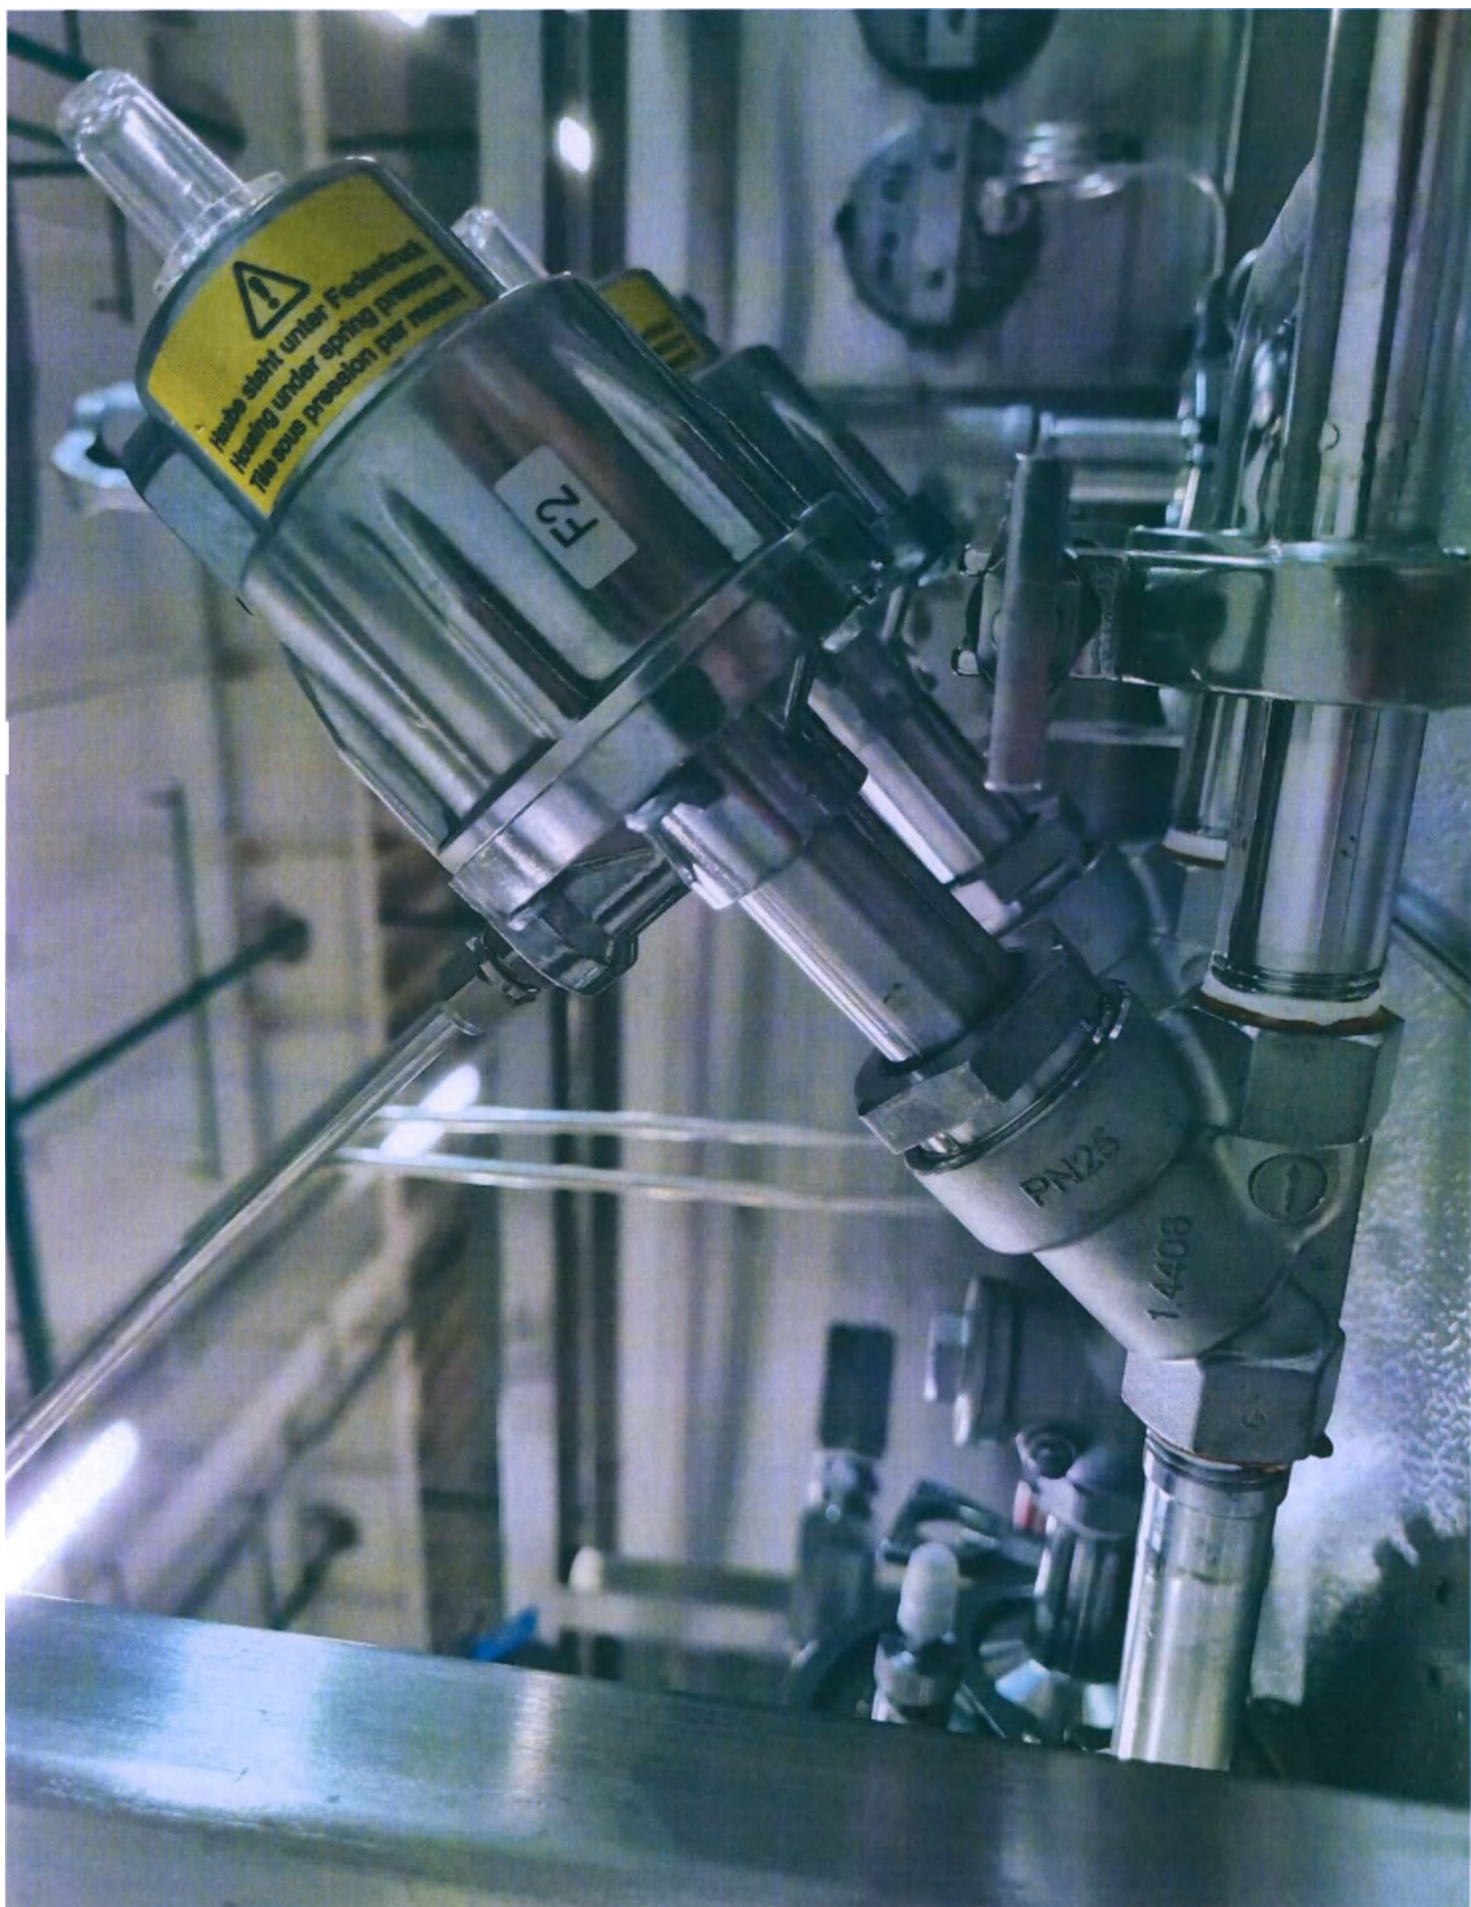

Клапан пневматический

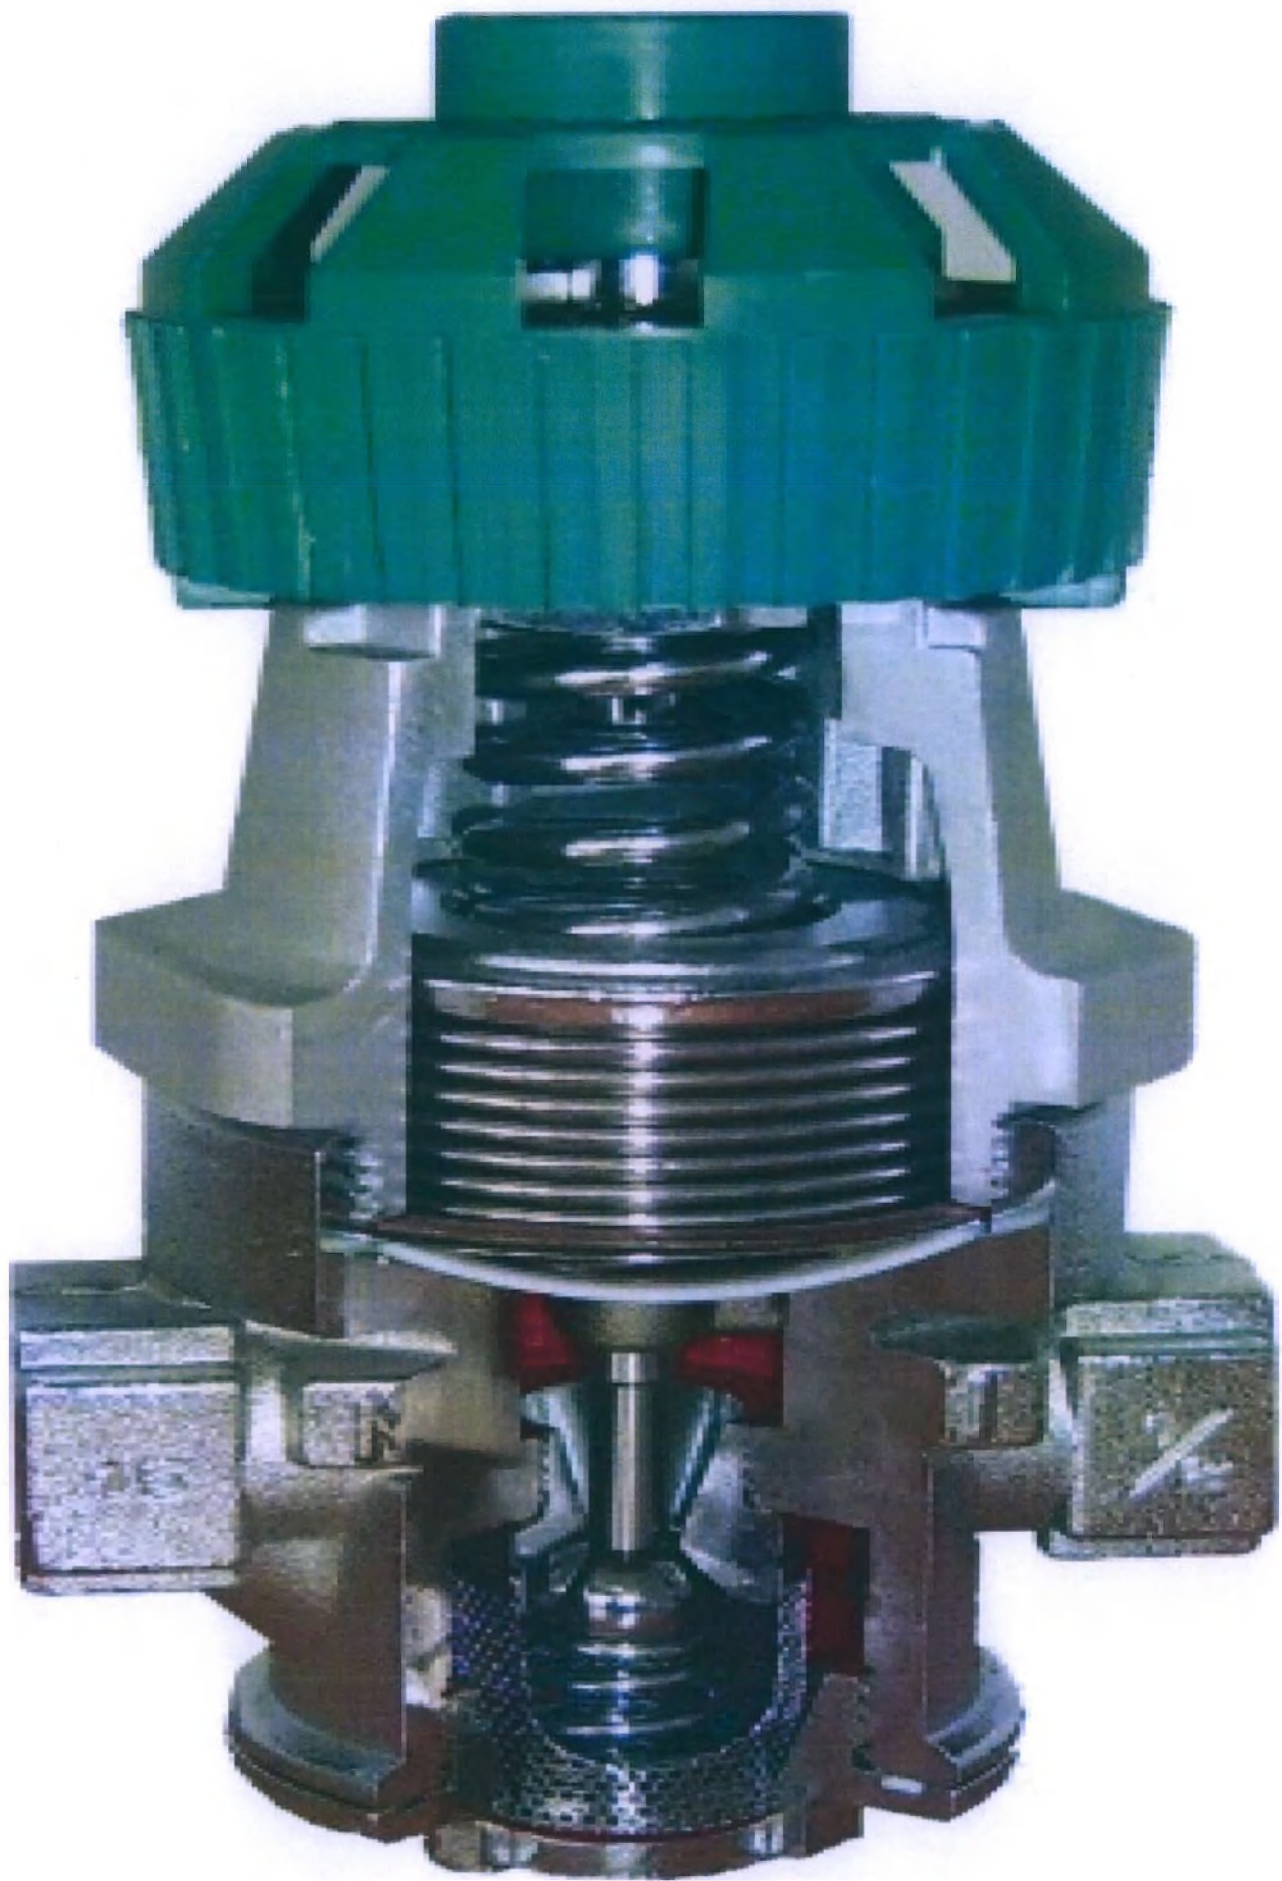

Клапан редукционный

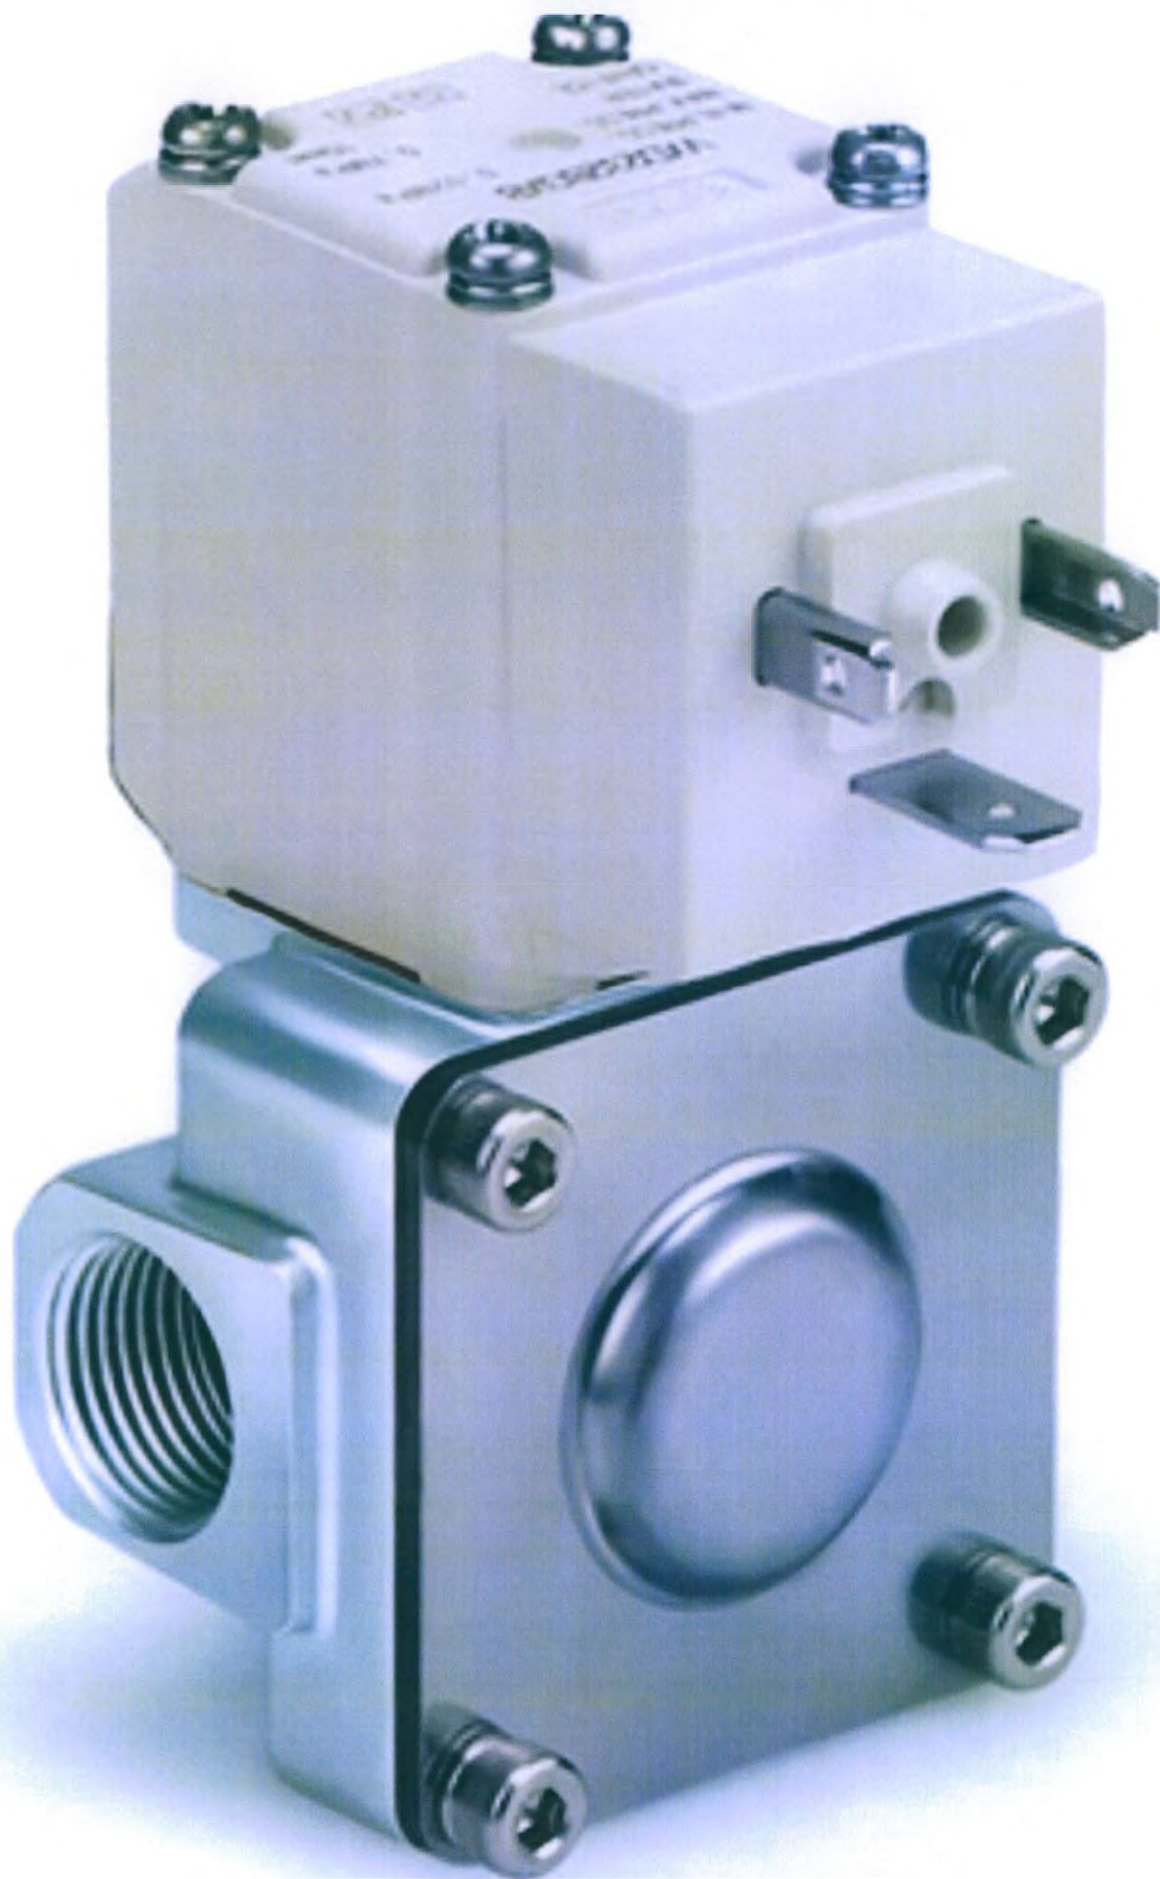

Клапан электромагнитный




Клапан электромагнитный трёхходовый



Кнопка включения/выключения



Кнопка аварийного отключения

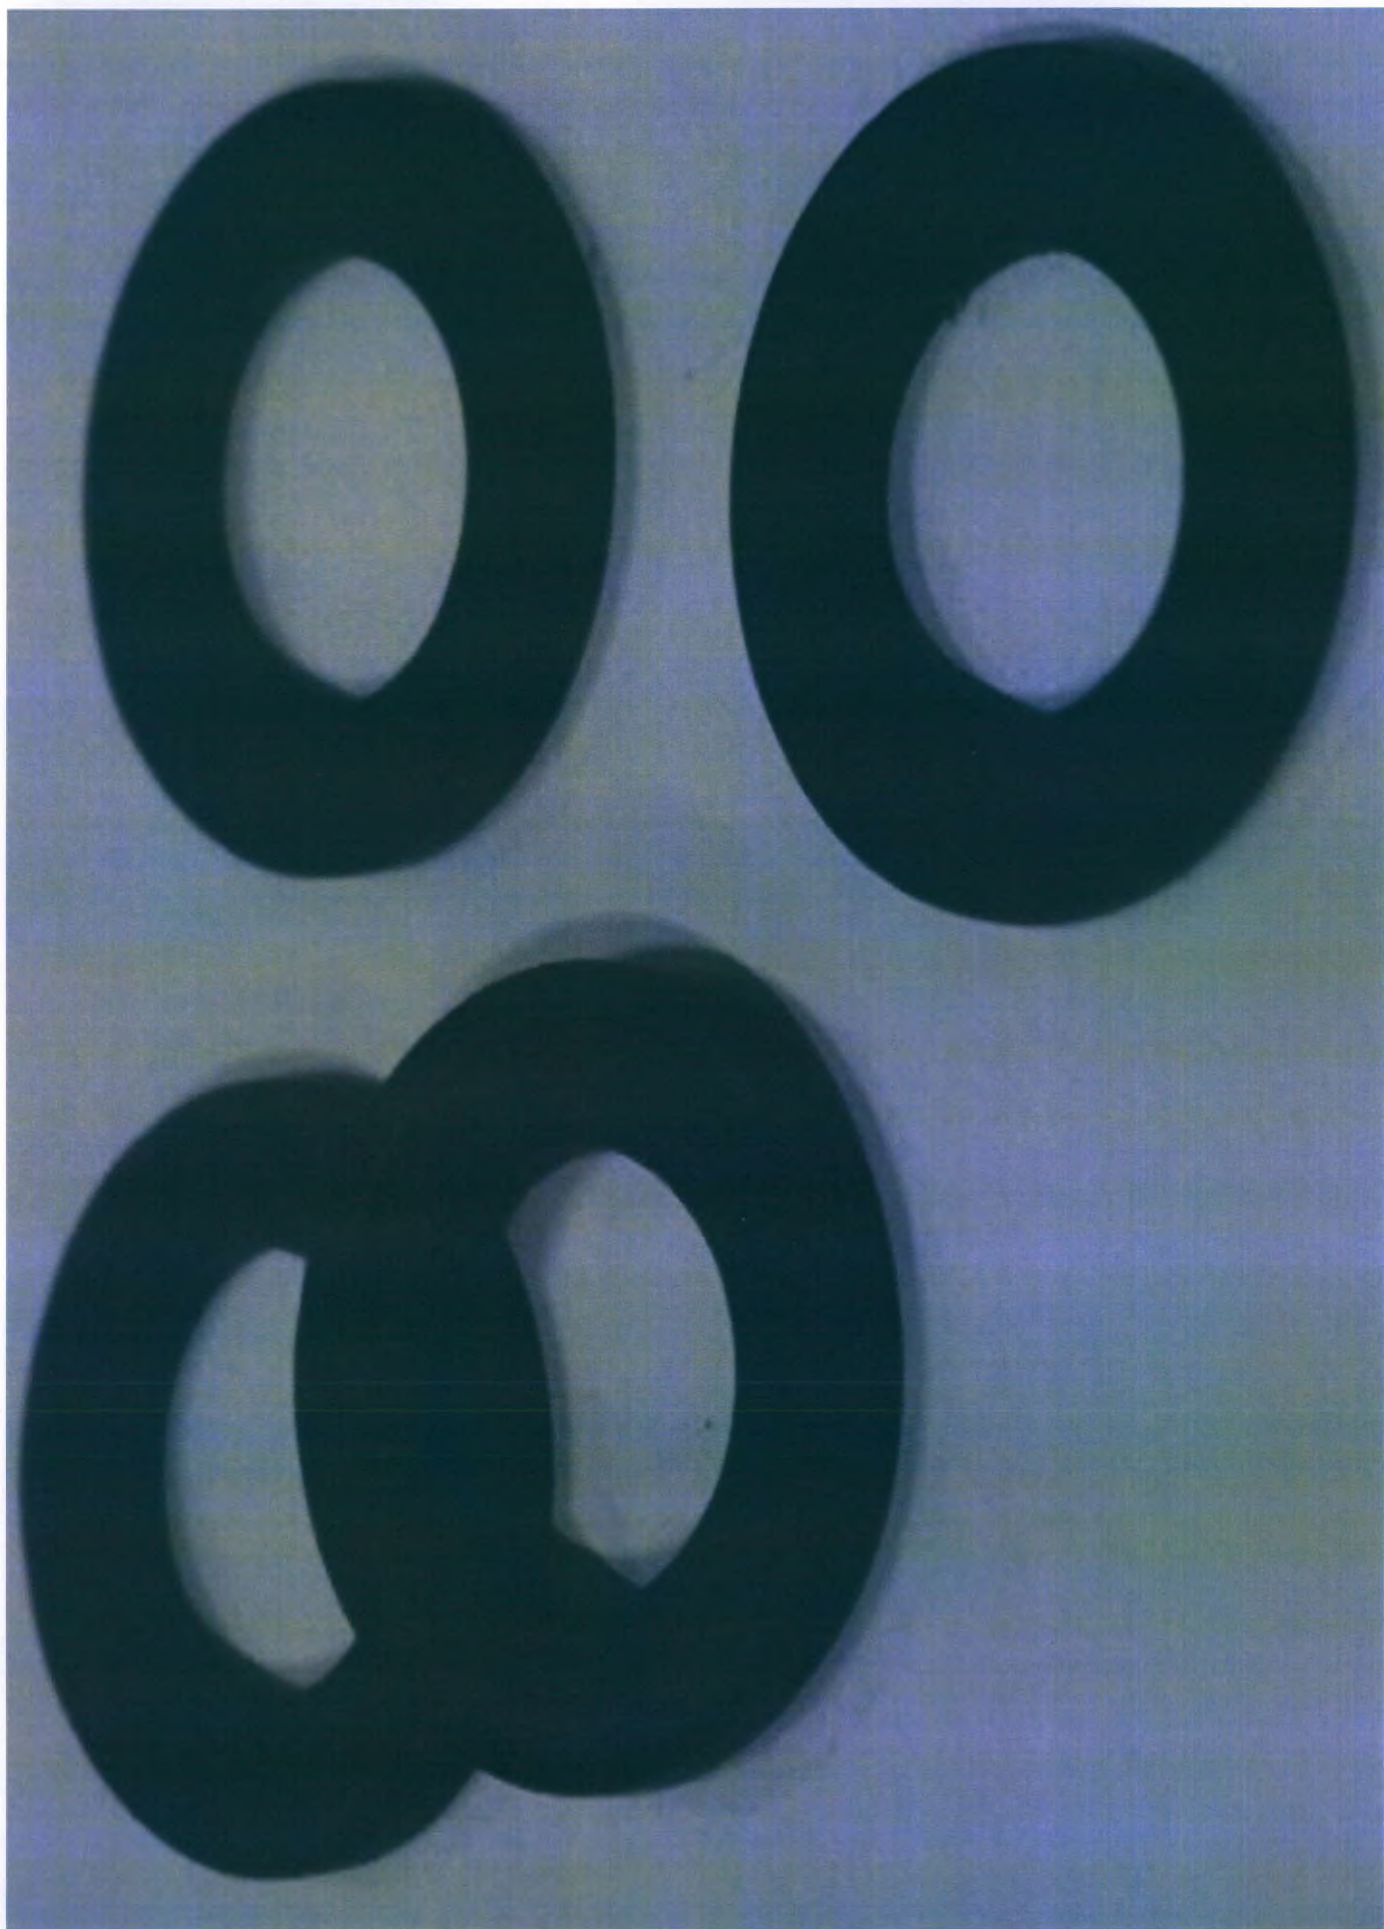

Кольцо уплотнительное



Колесо поворотное



ИЛД



Компрессор малый (для исполнений DGM - 130, DGM - 240, DGM - 360, DGM - 600, DGM - 800, DGM - 1000)




Или



Компрессор большой (для исполнений DGM - 1000, DGM - 1200, DGM - 1500, DGM – 2000)




Конденсатоотводчик

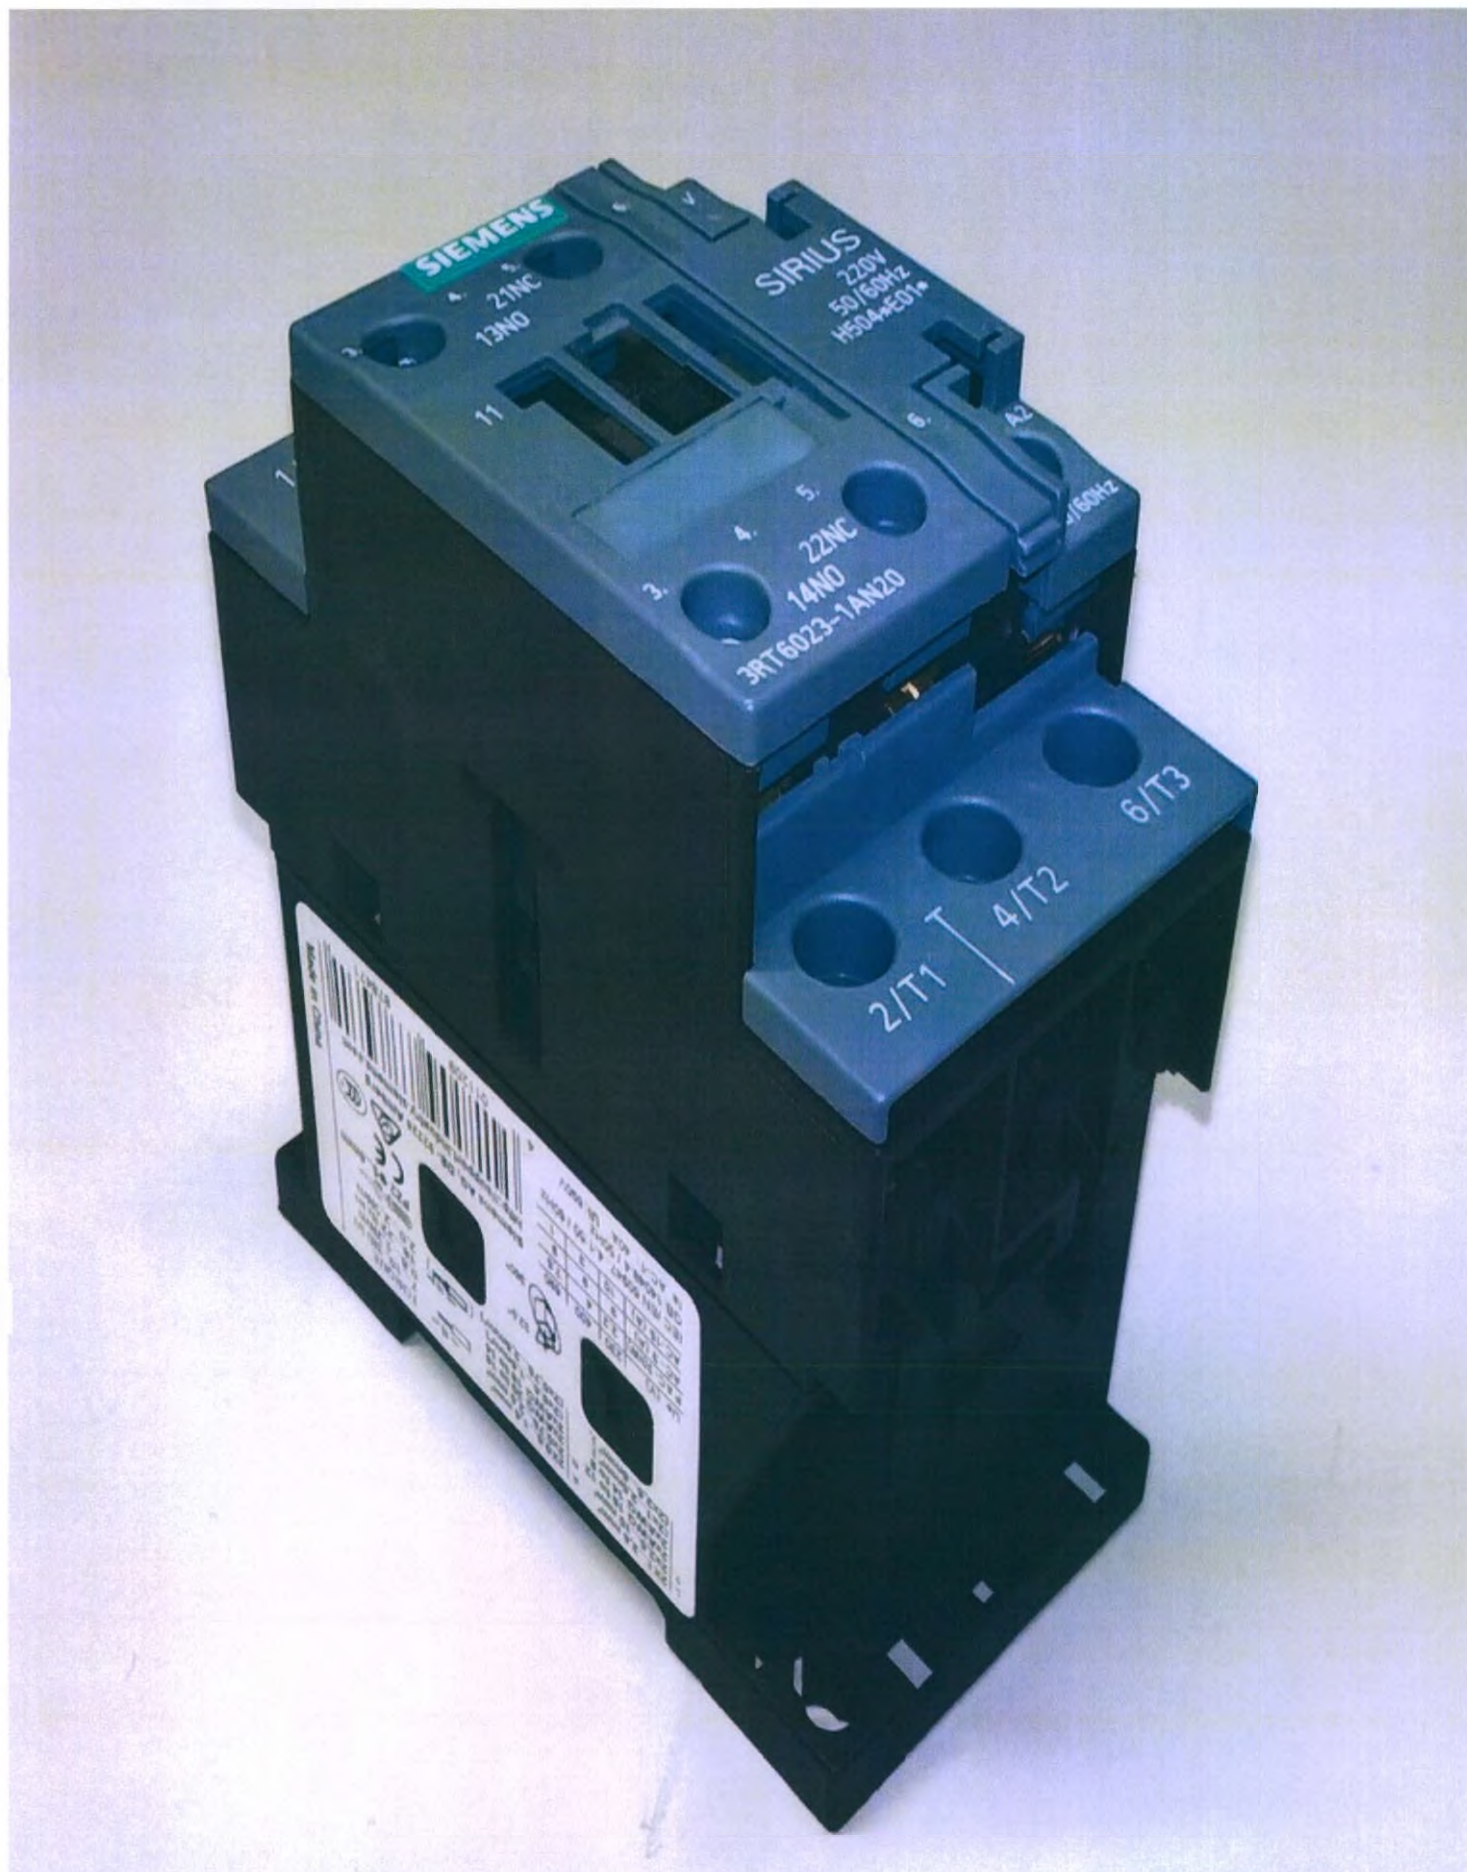

Контактор




Контроллер давления

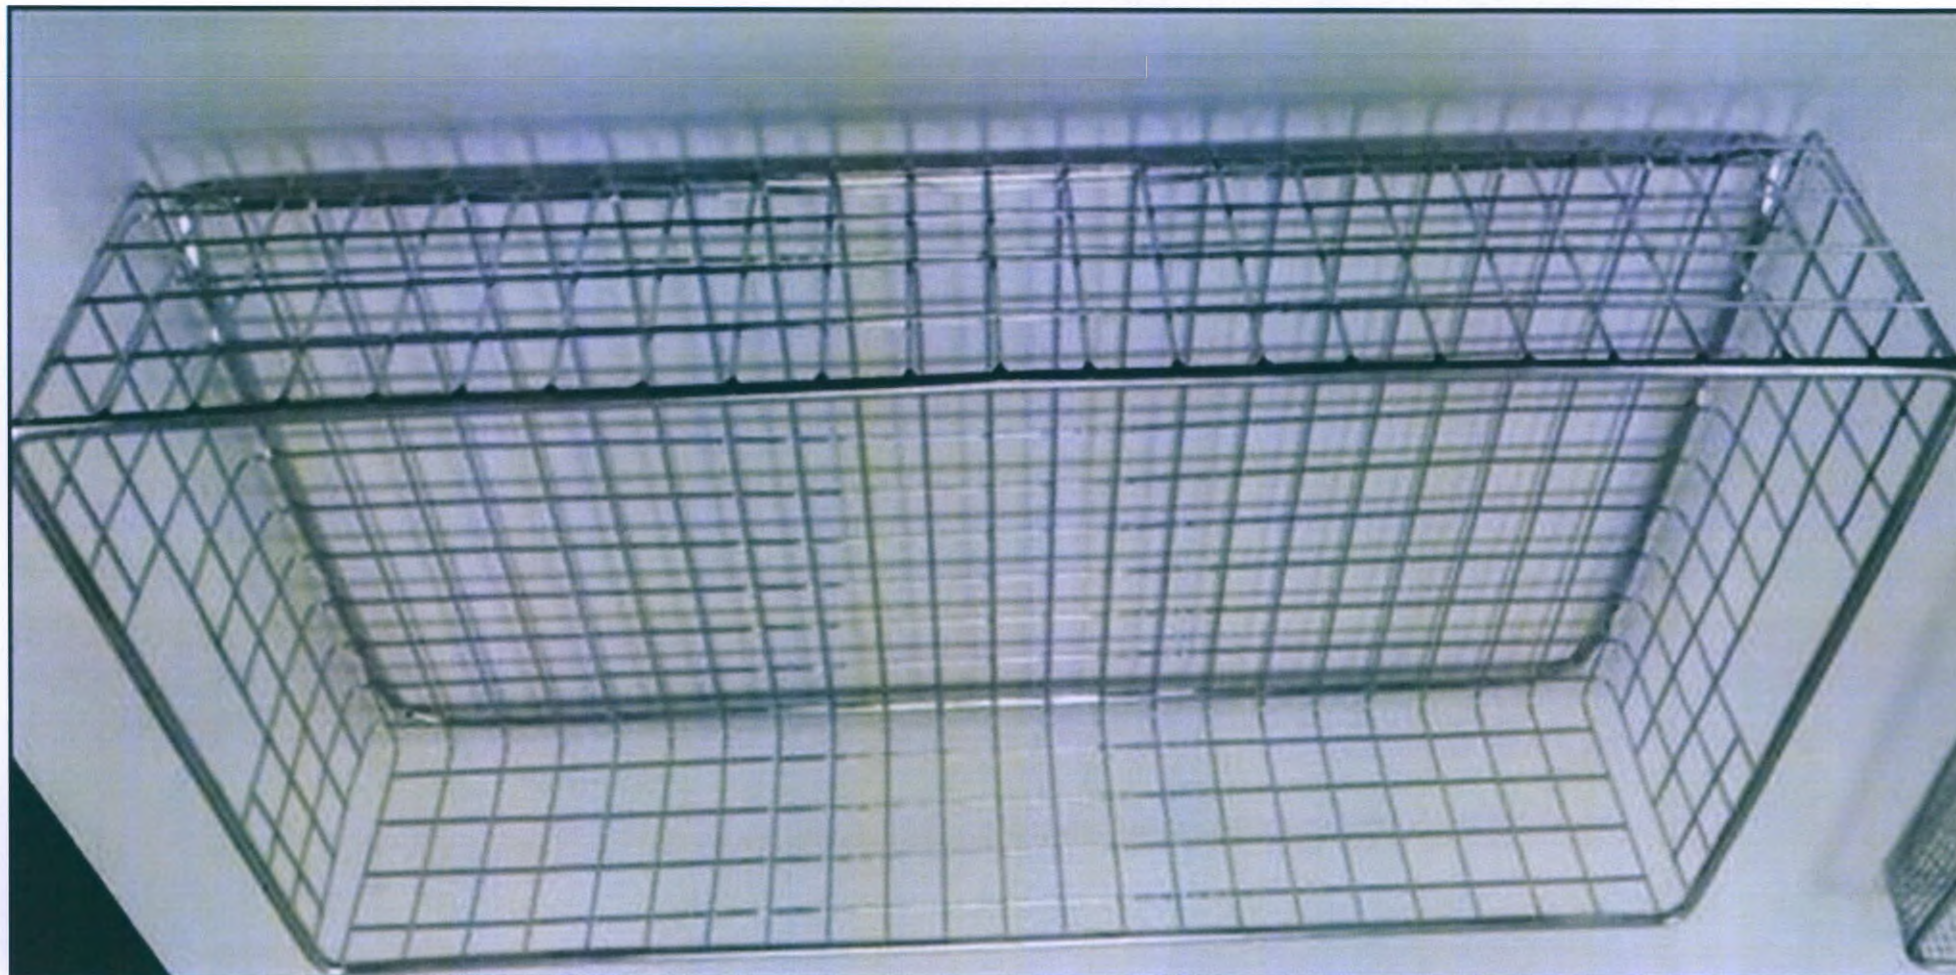

Или

или

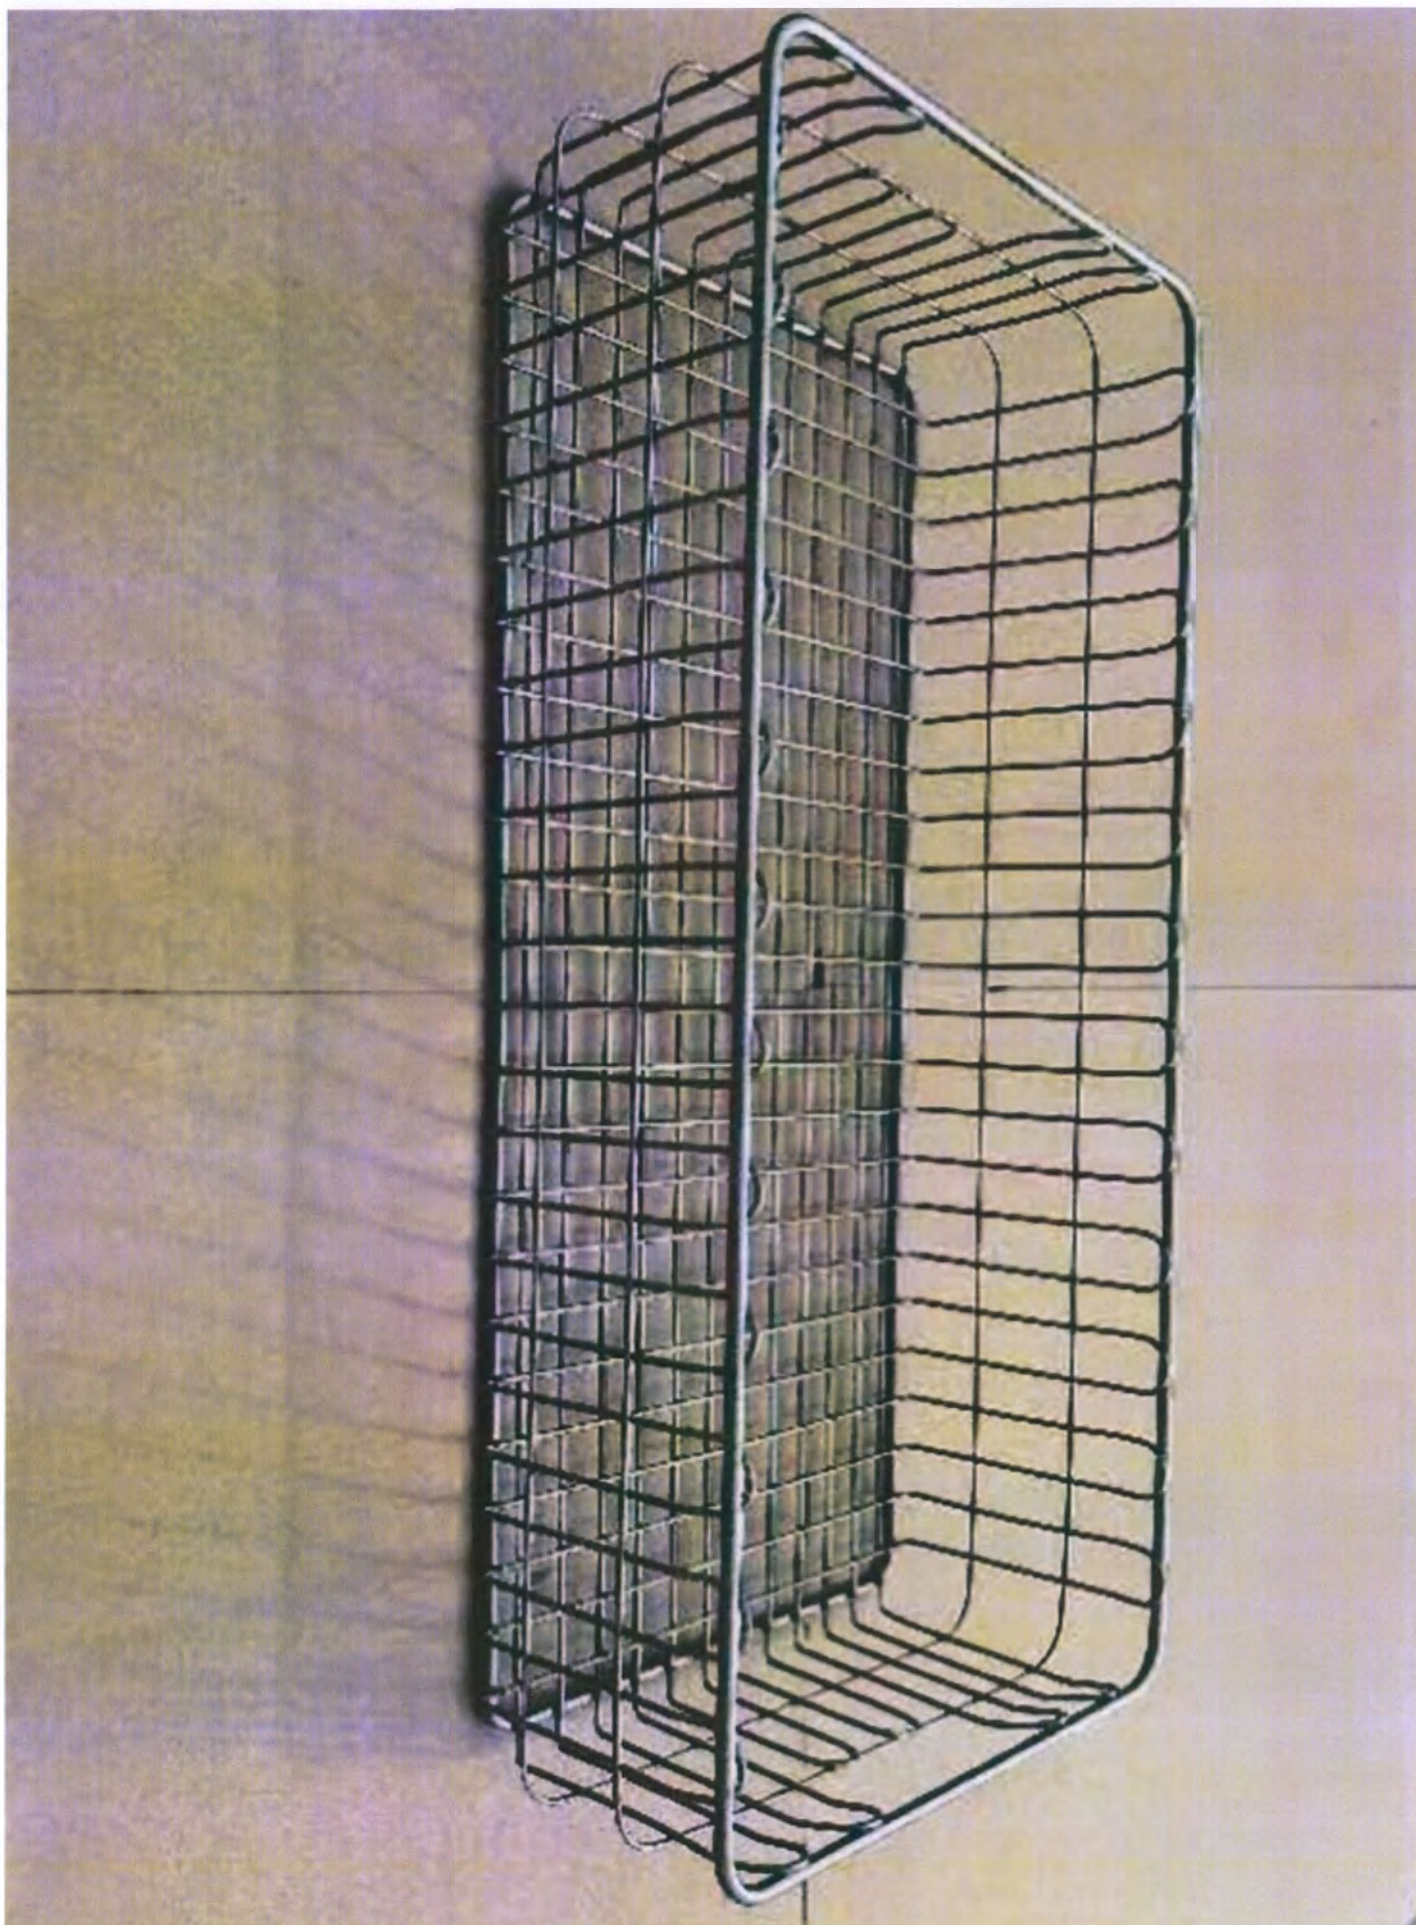



Корзина стерилизационная малая




Или

ИИ






Корзина стерилизационная большая

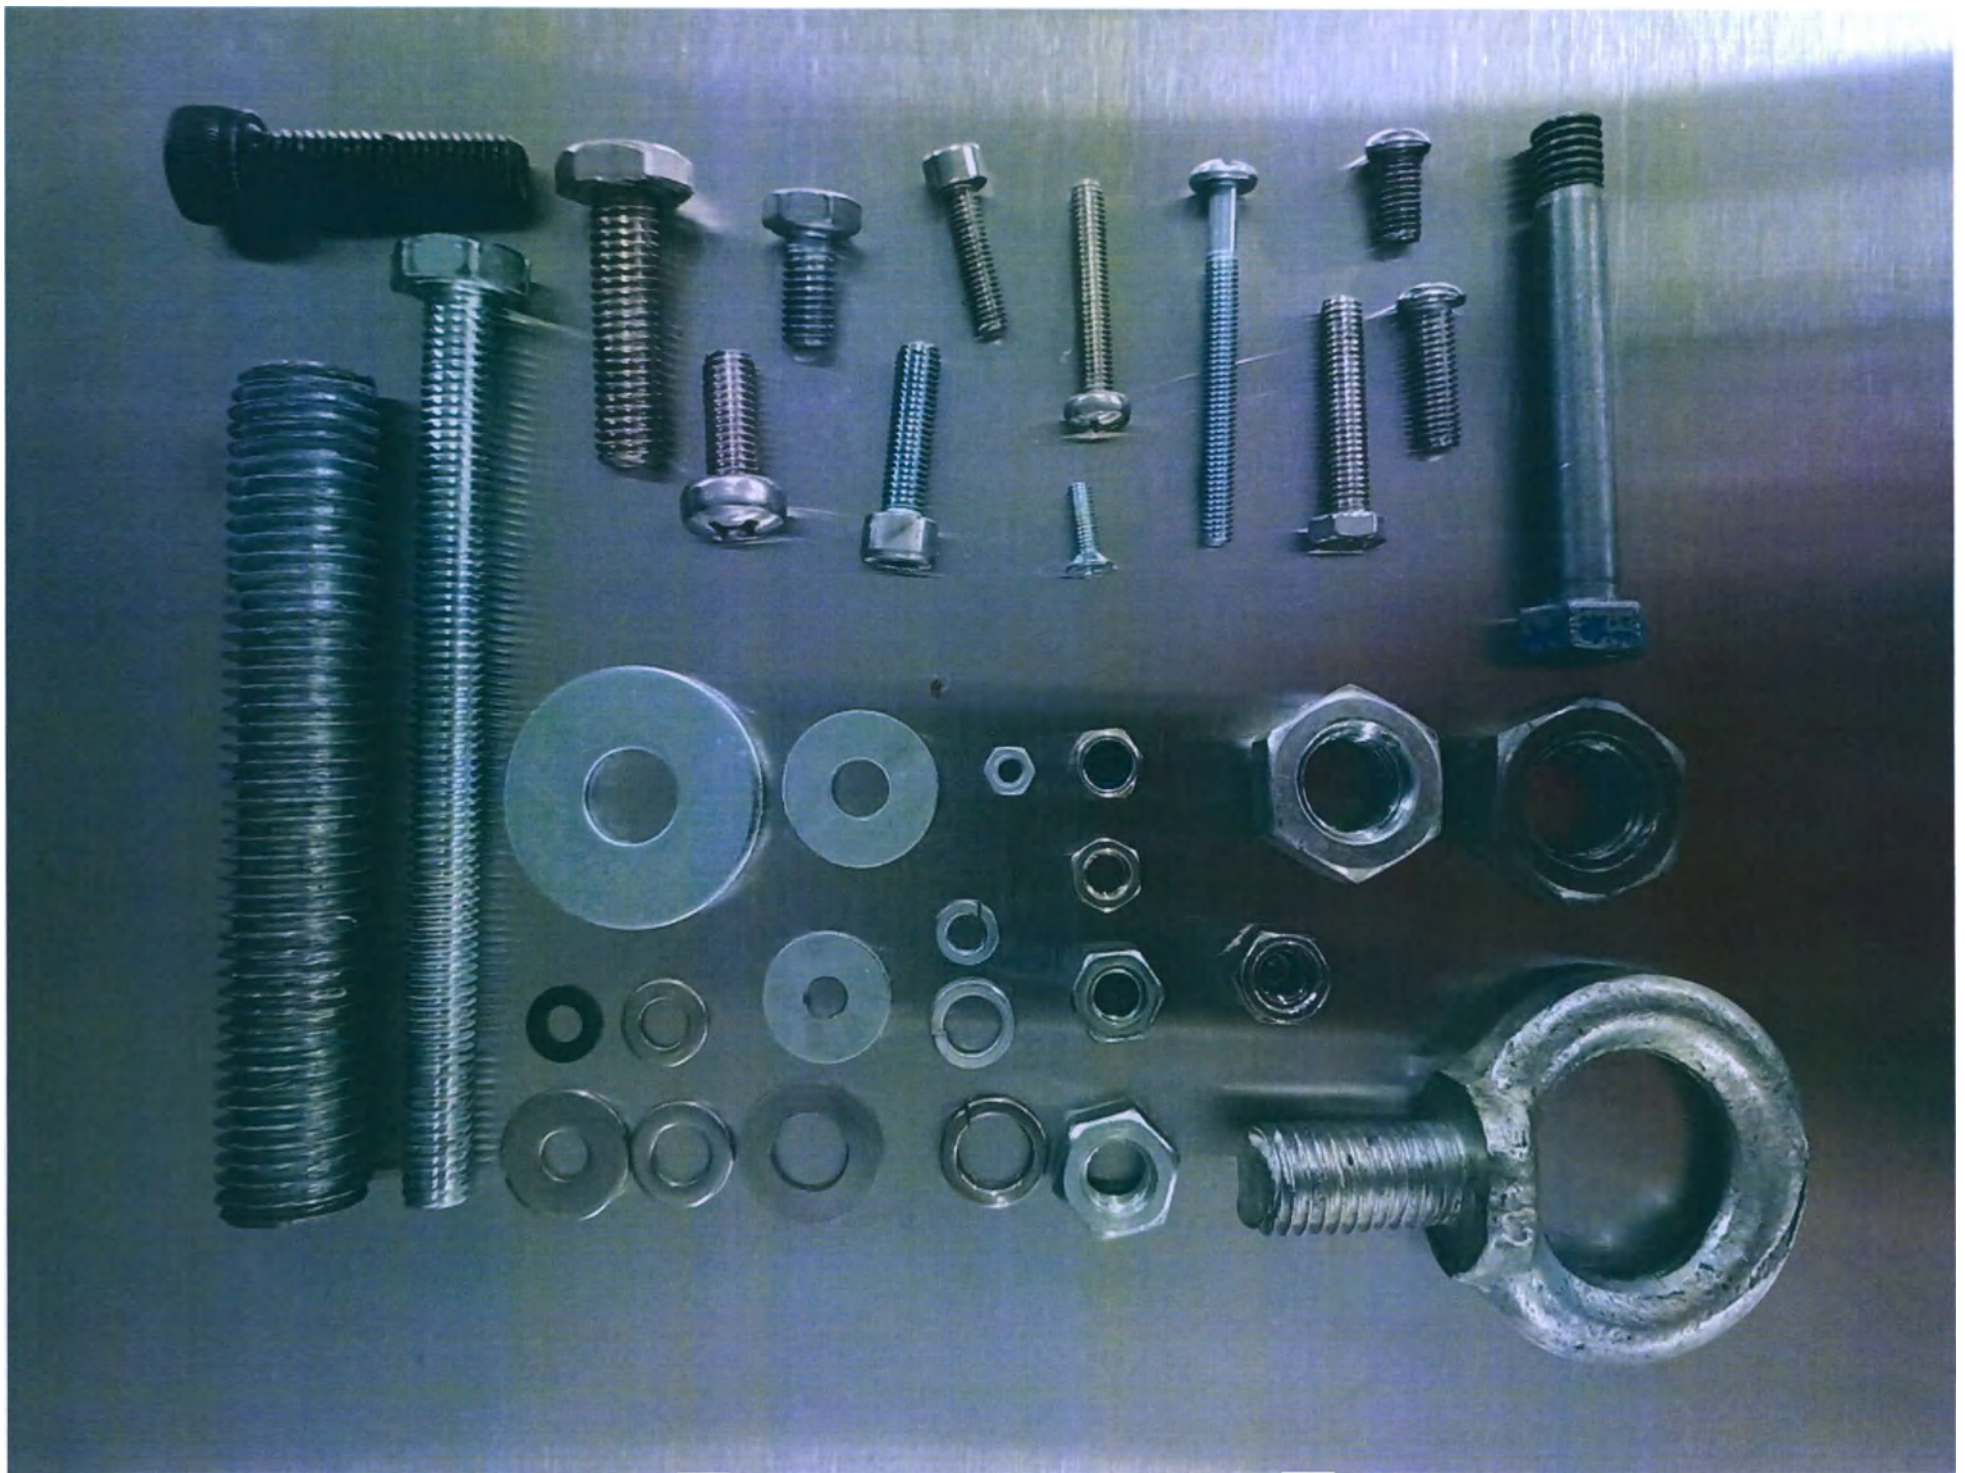




Крышка пластмассовая

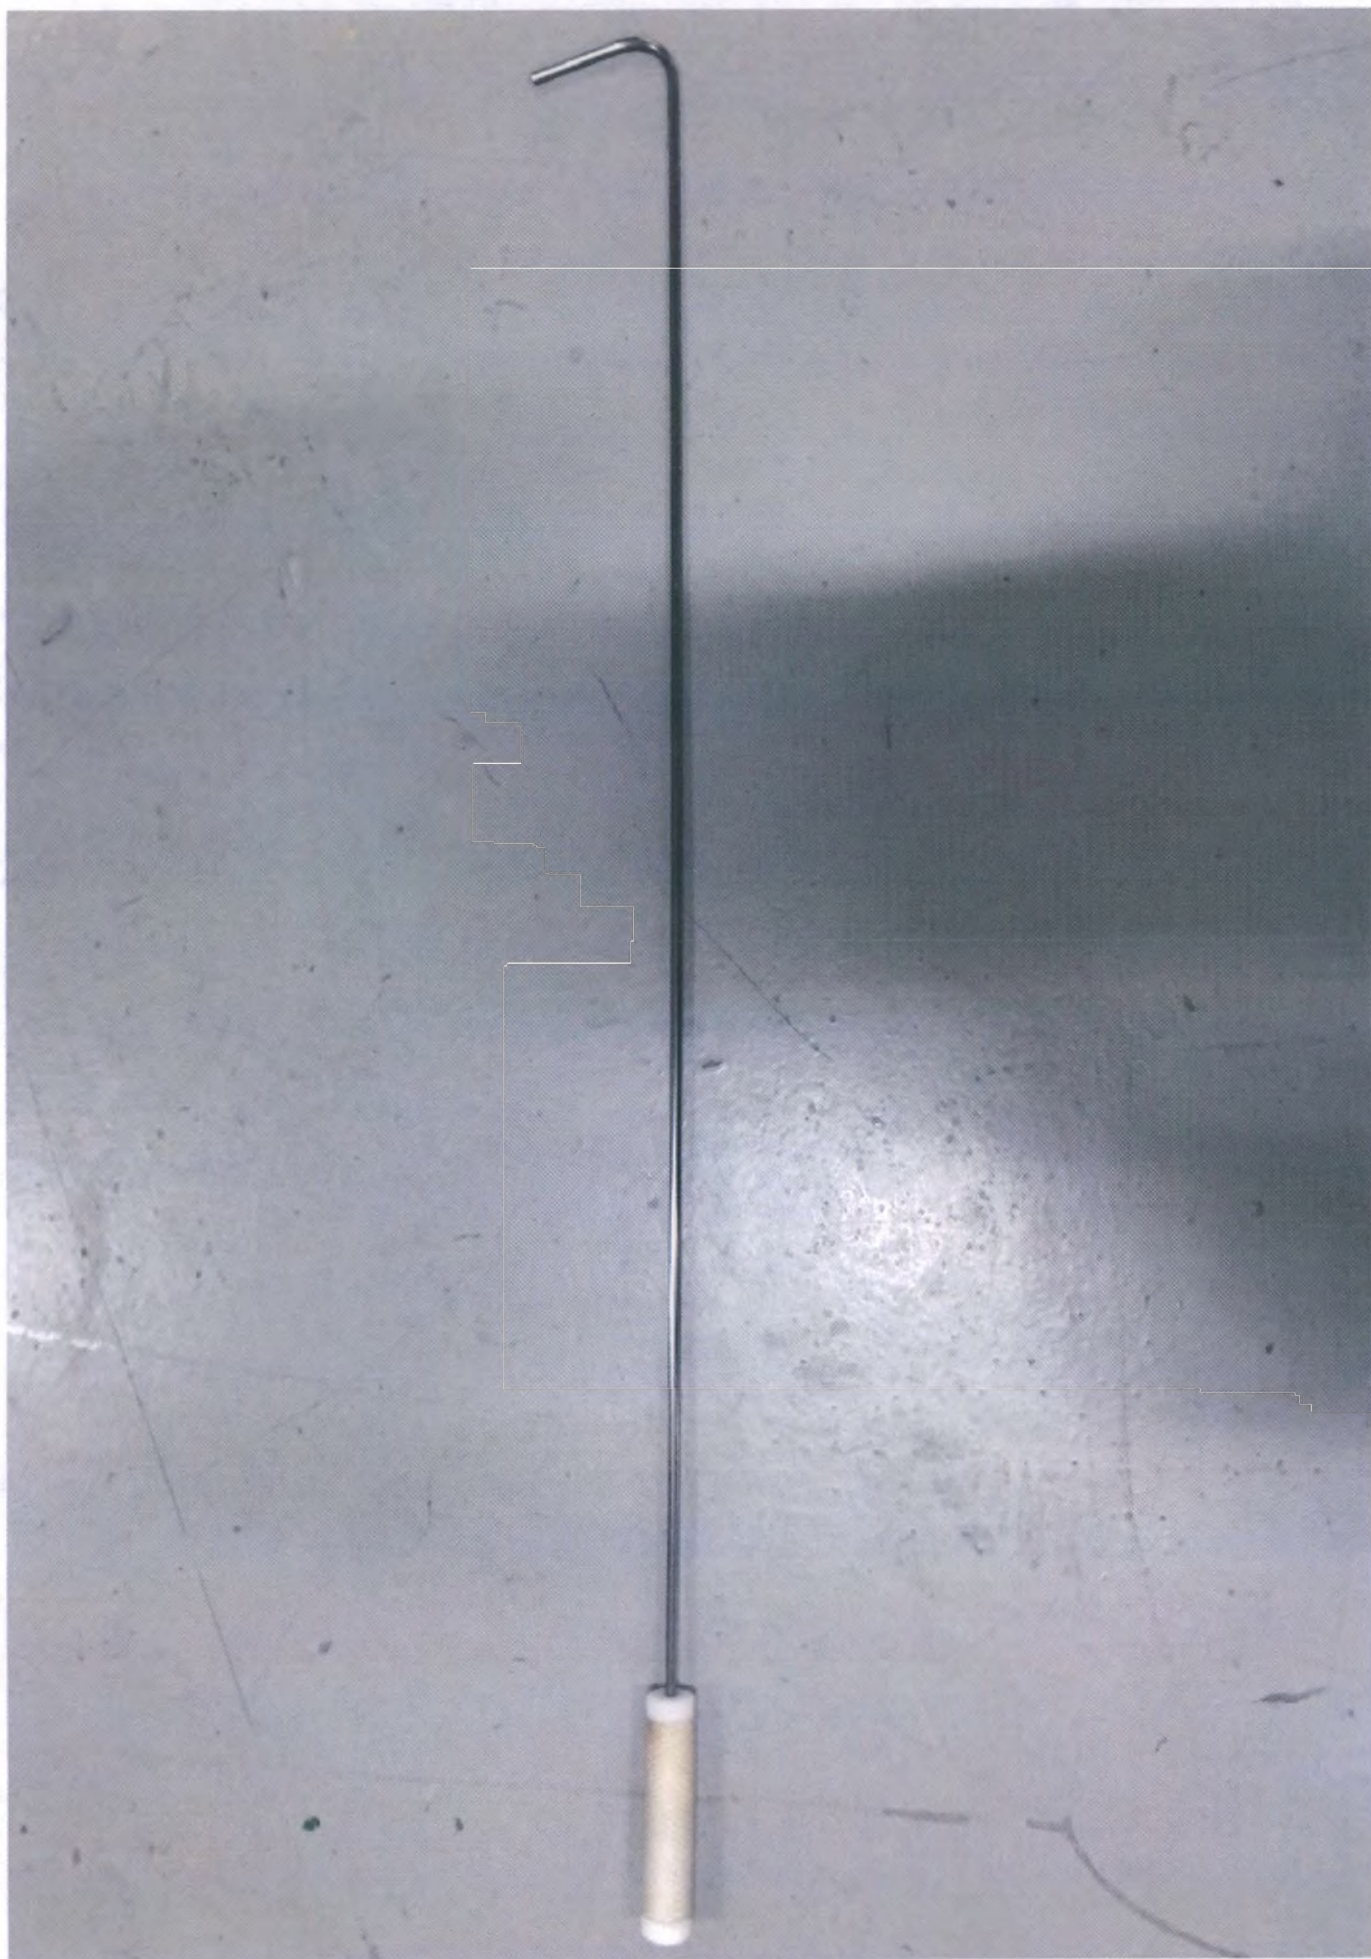

Крюк для выгрузки тележки из камеры



Лампа индикаторная

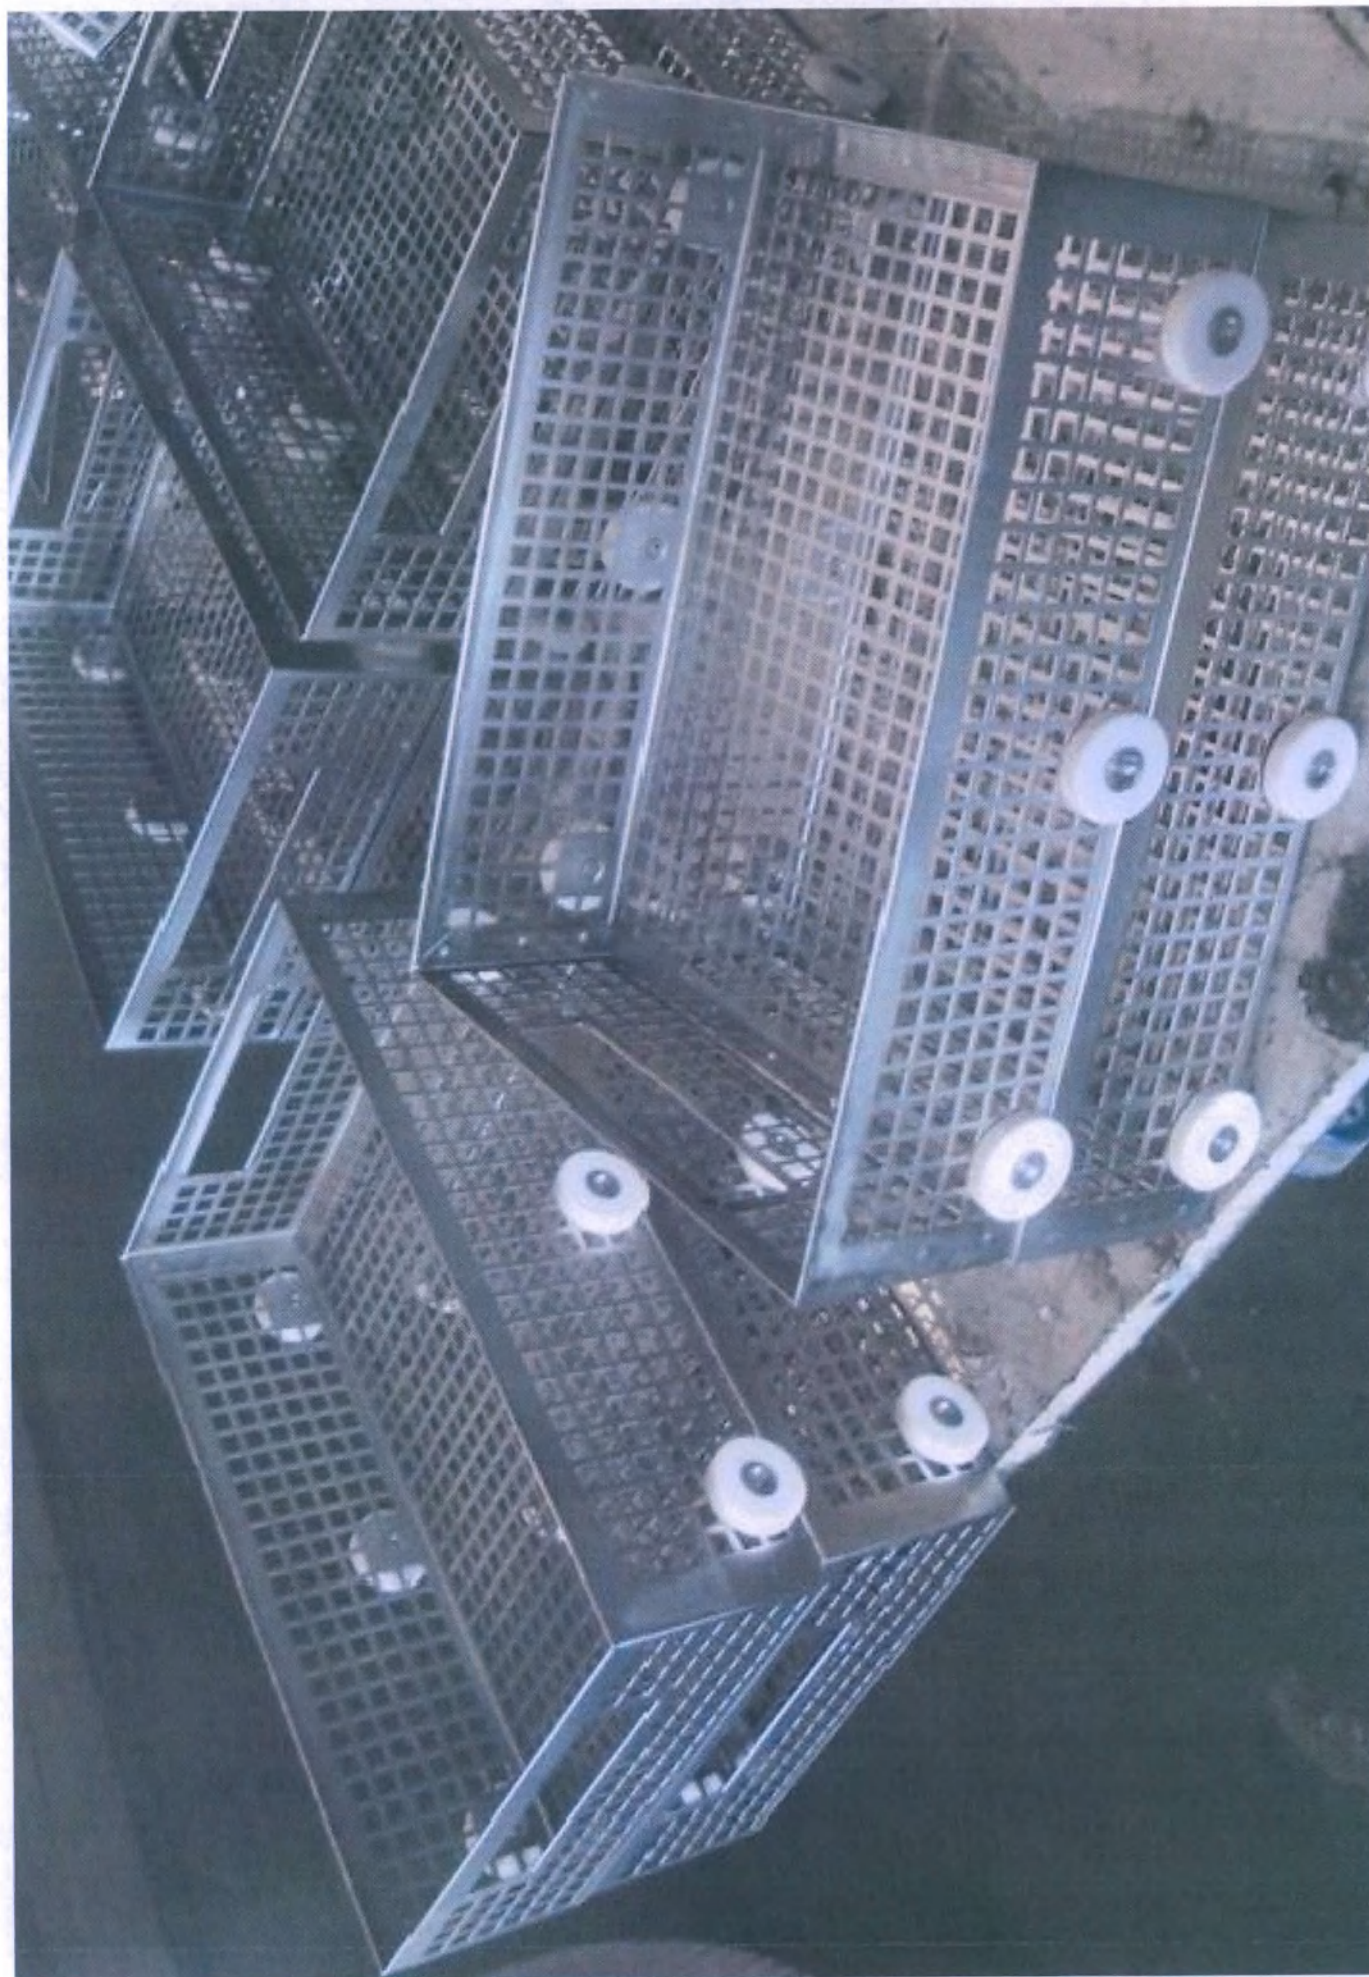


Лоток



Манометр камеры



Манометр рубашки (парогенератора)

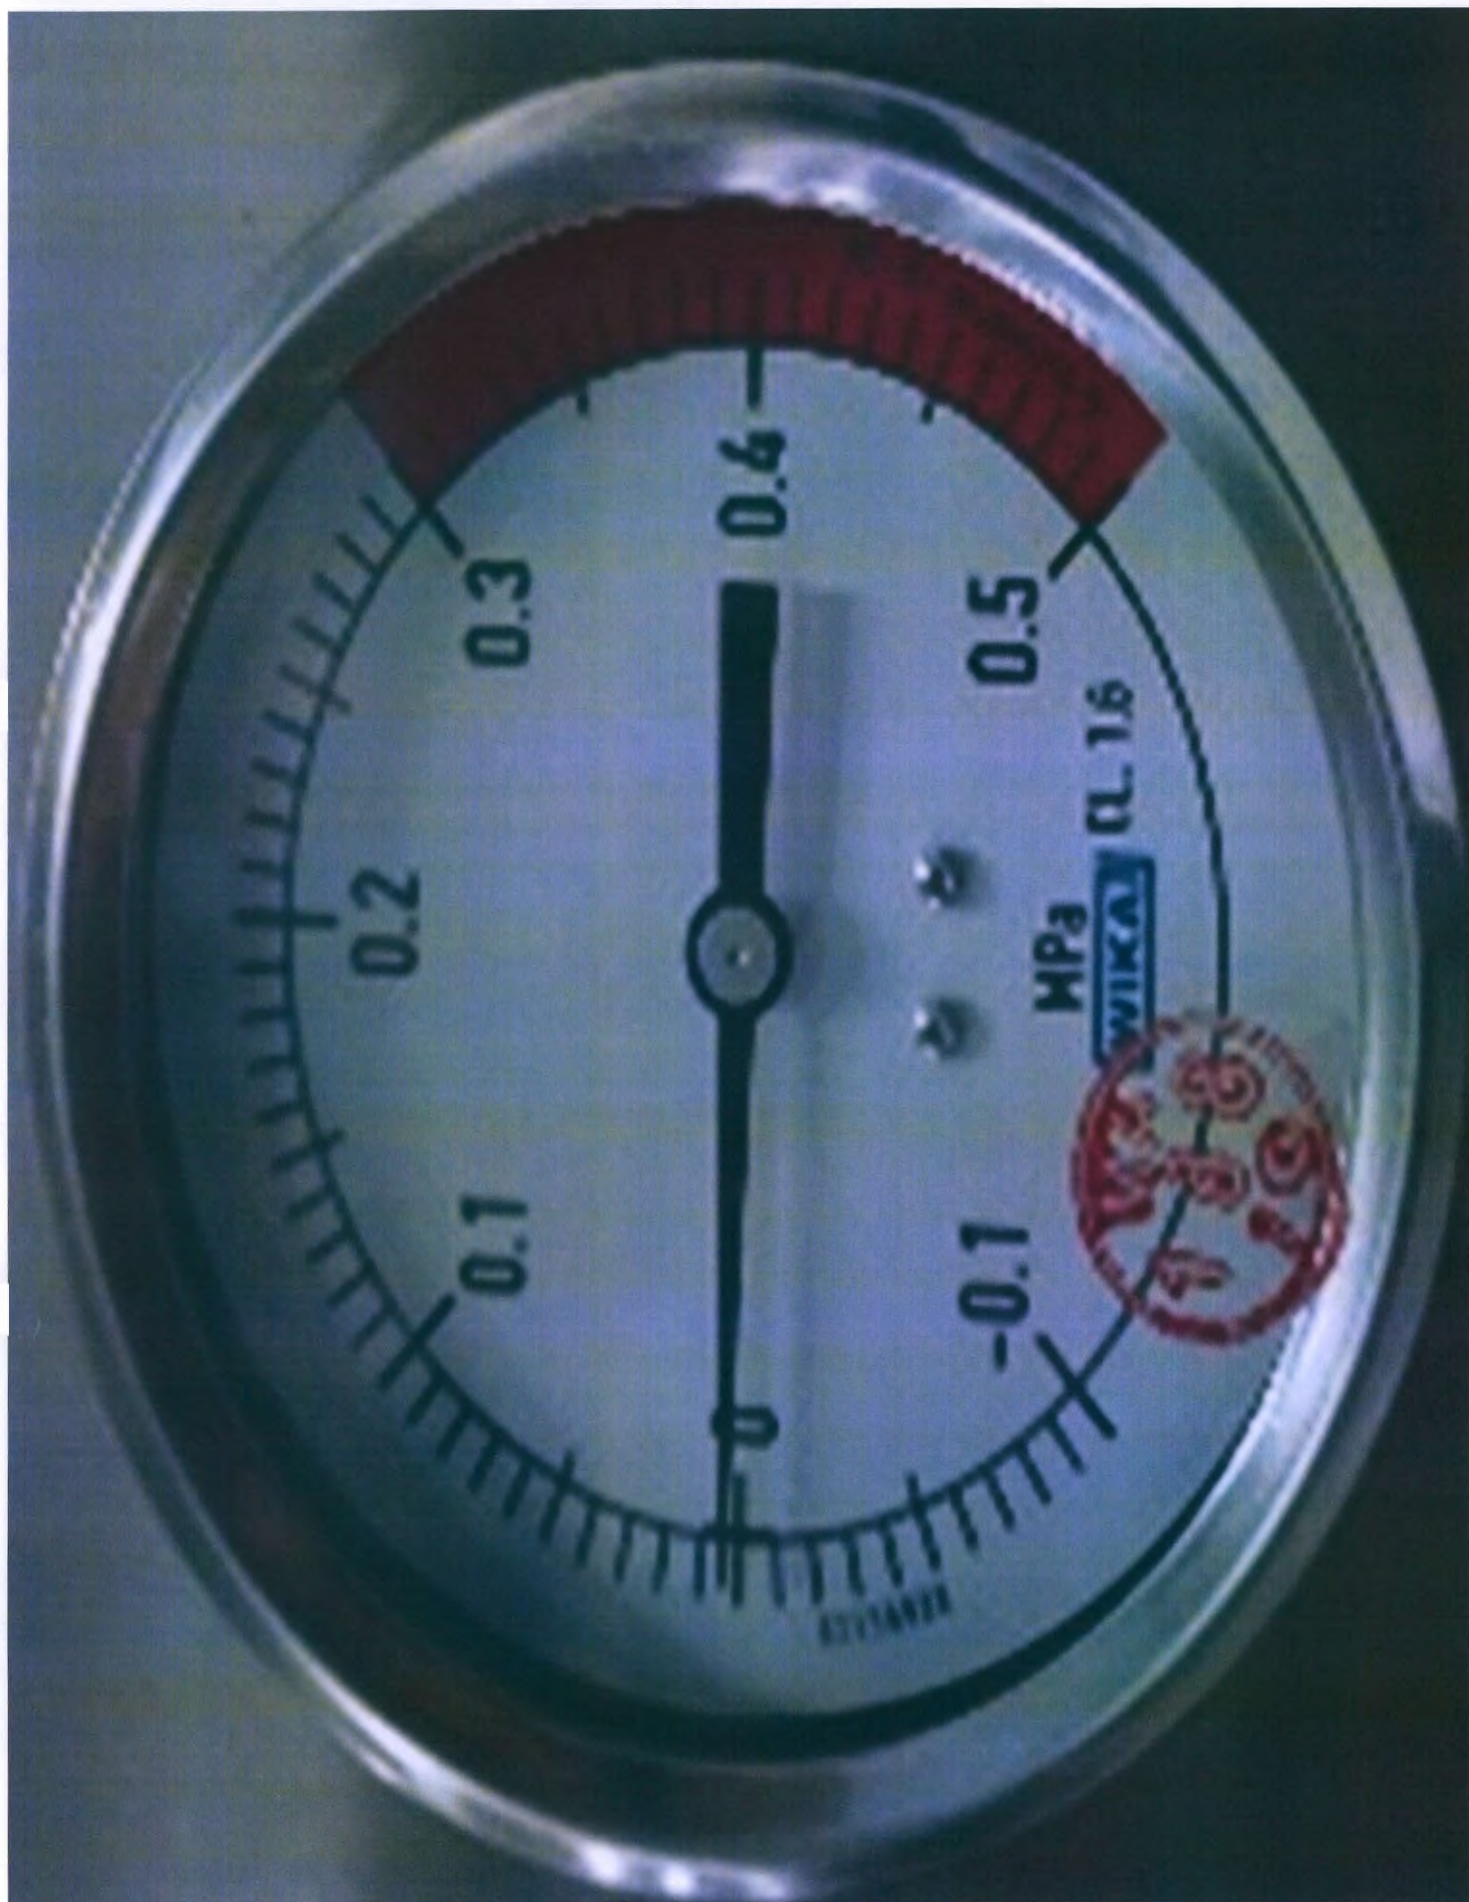


Мановакуумметр камеры



Направляющие лотка




Насос вакуумный

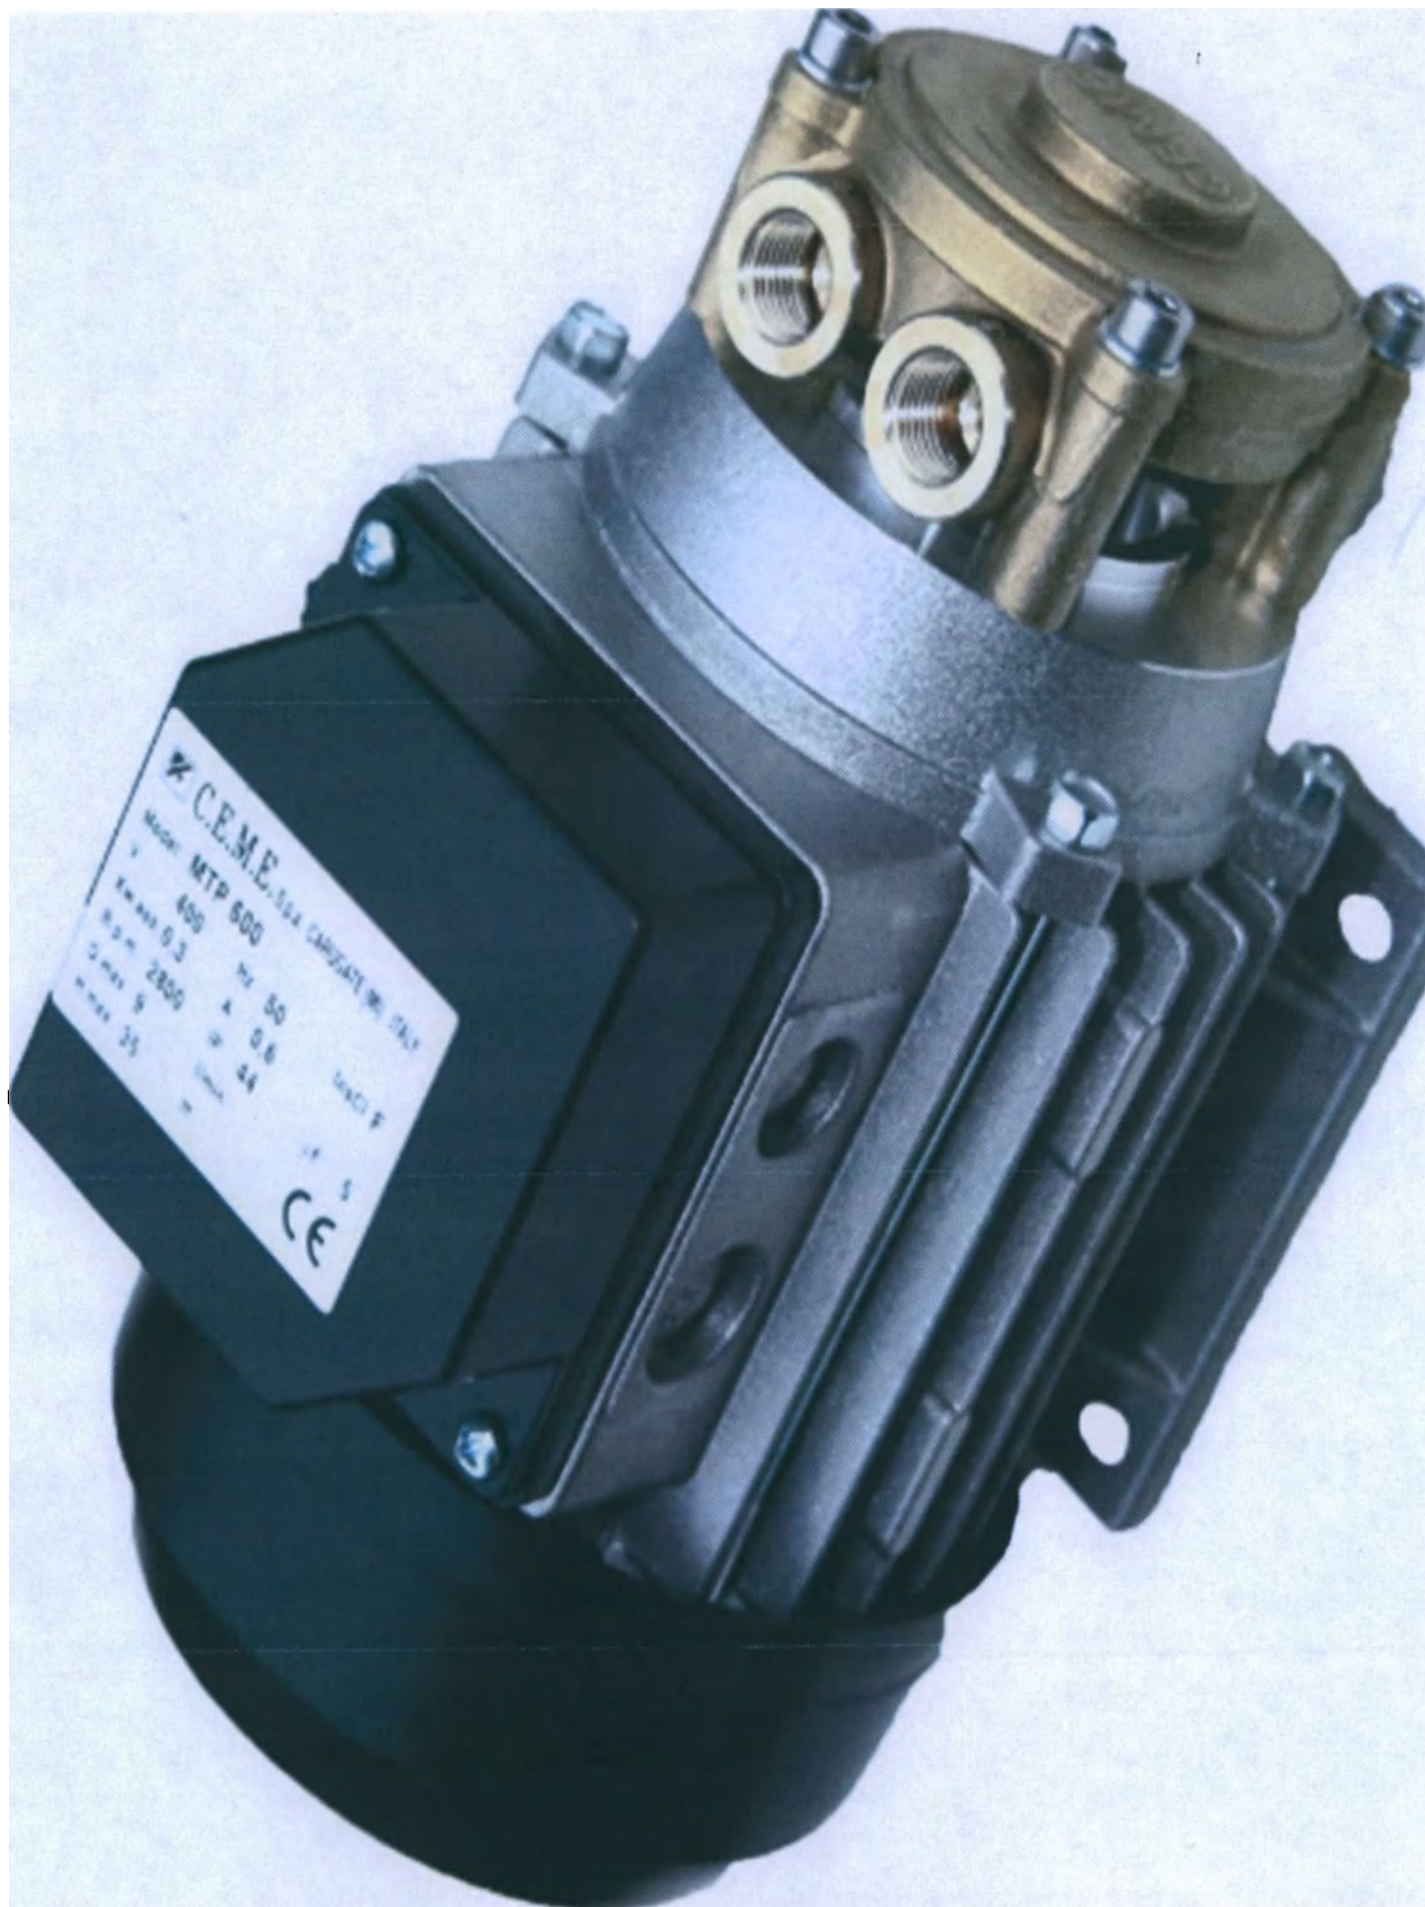

Насос




Опора

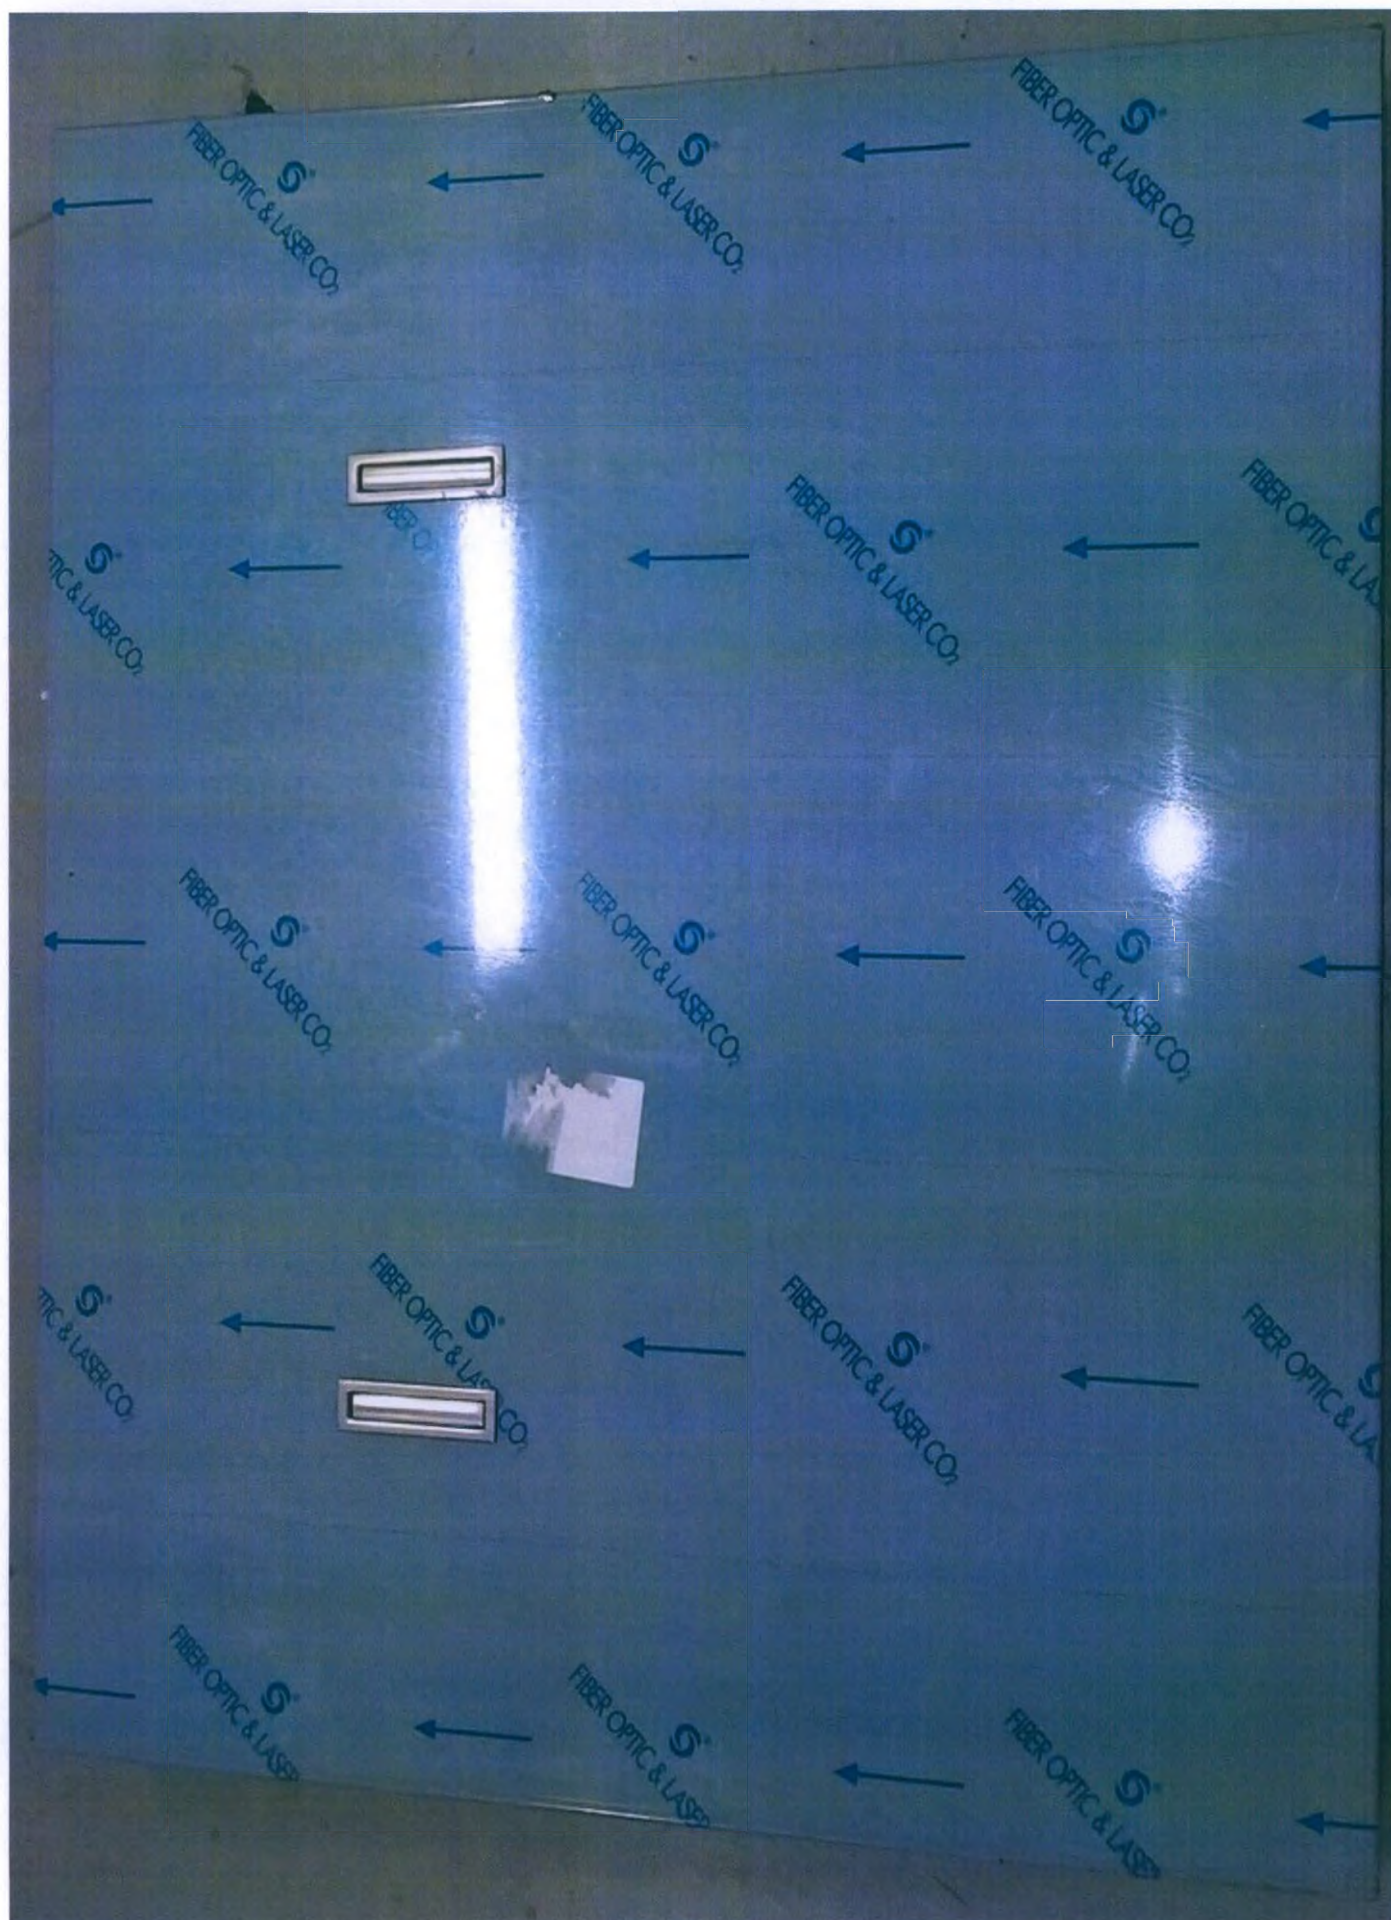


Панель внешняя



Панель для разделения зон

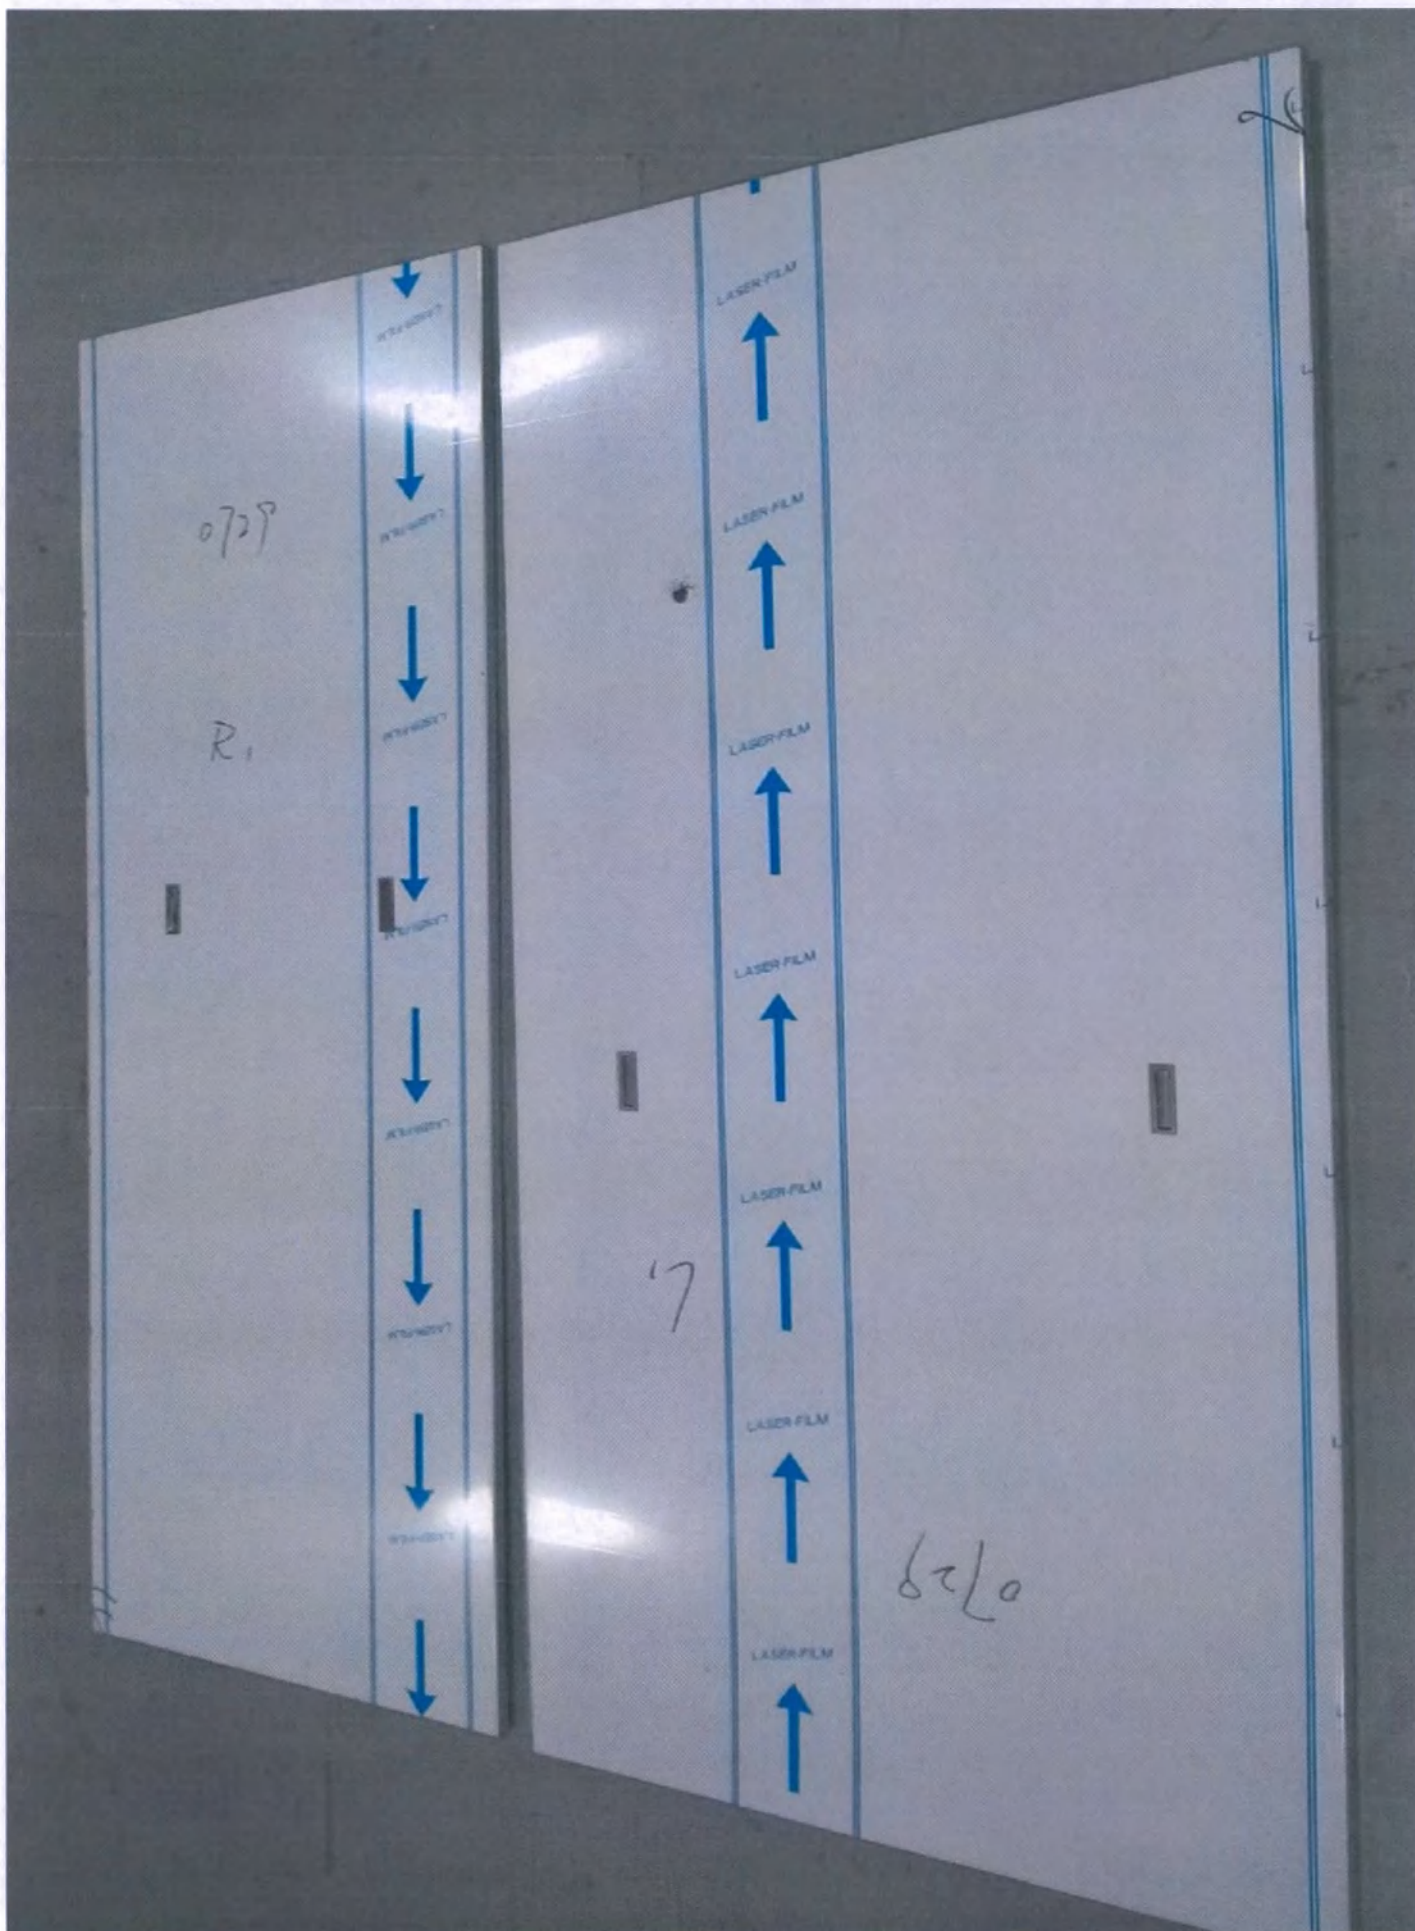

Панель облицовочная

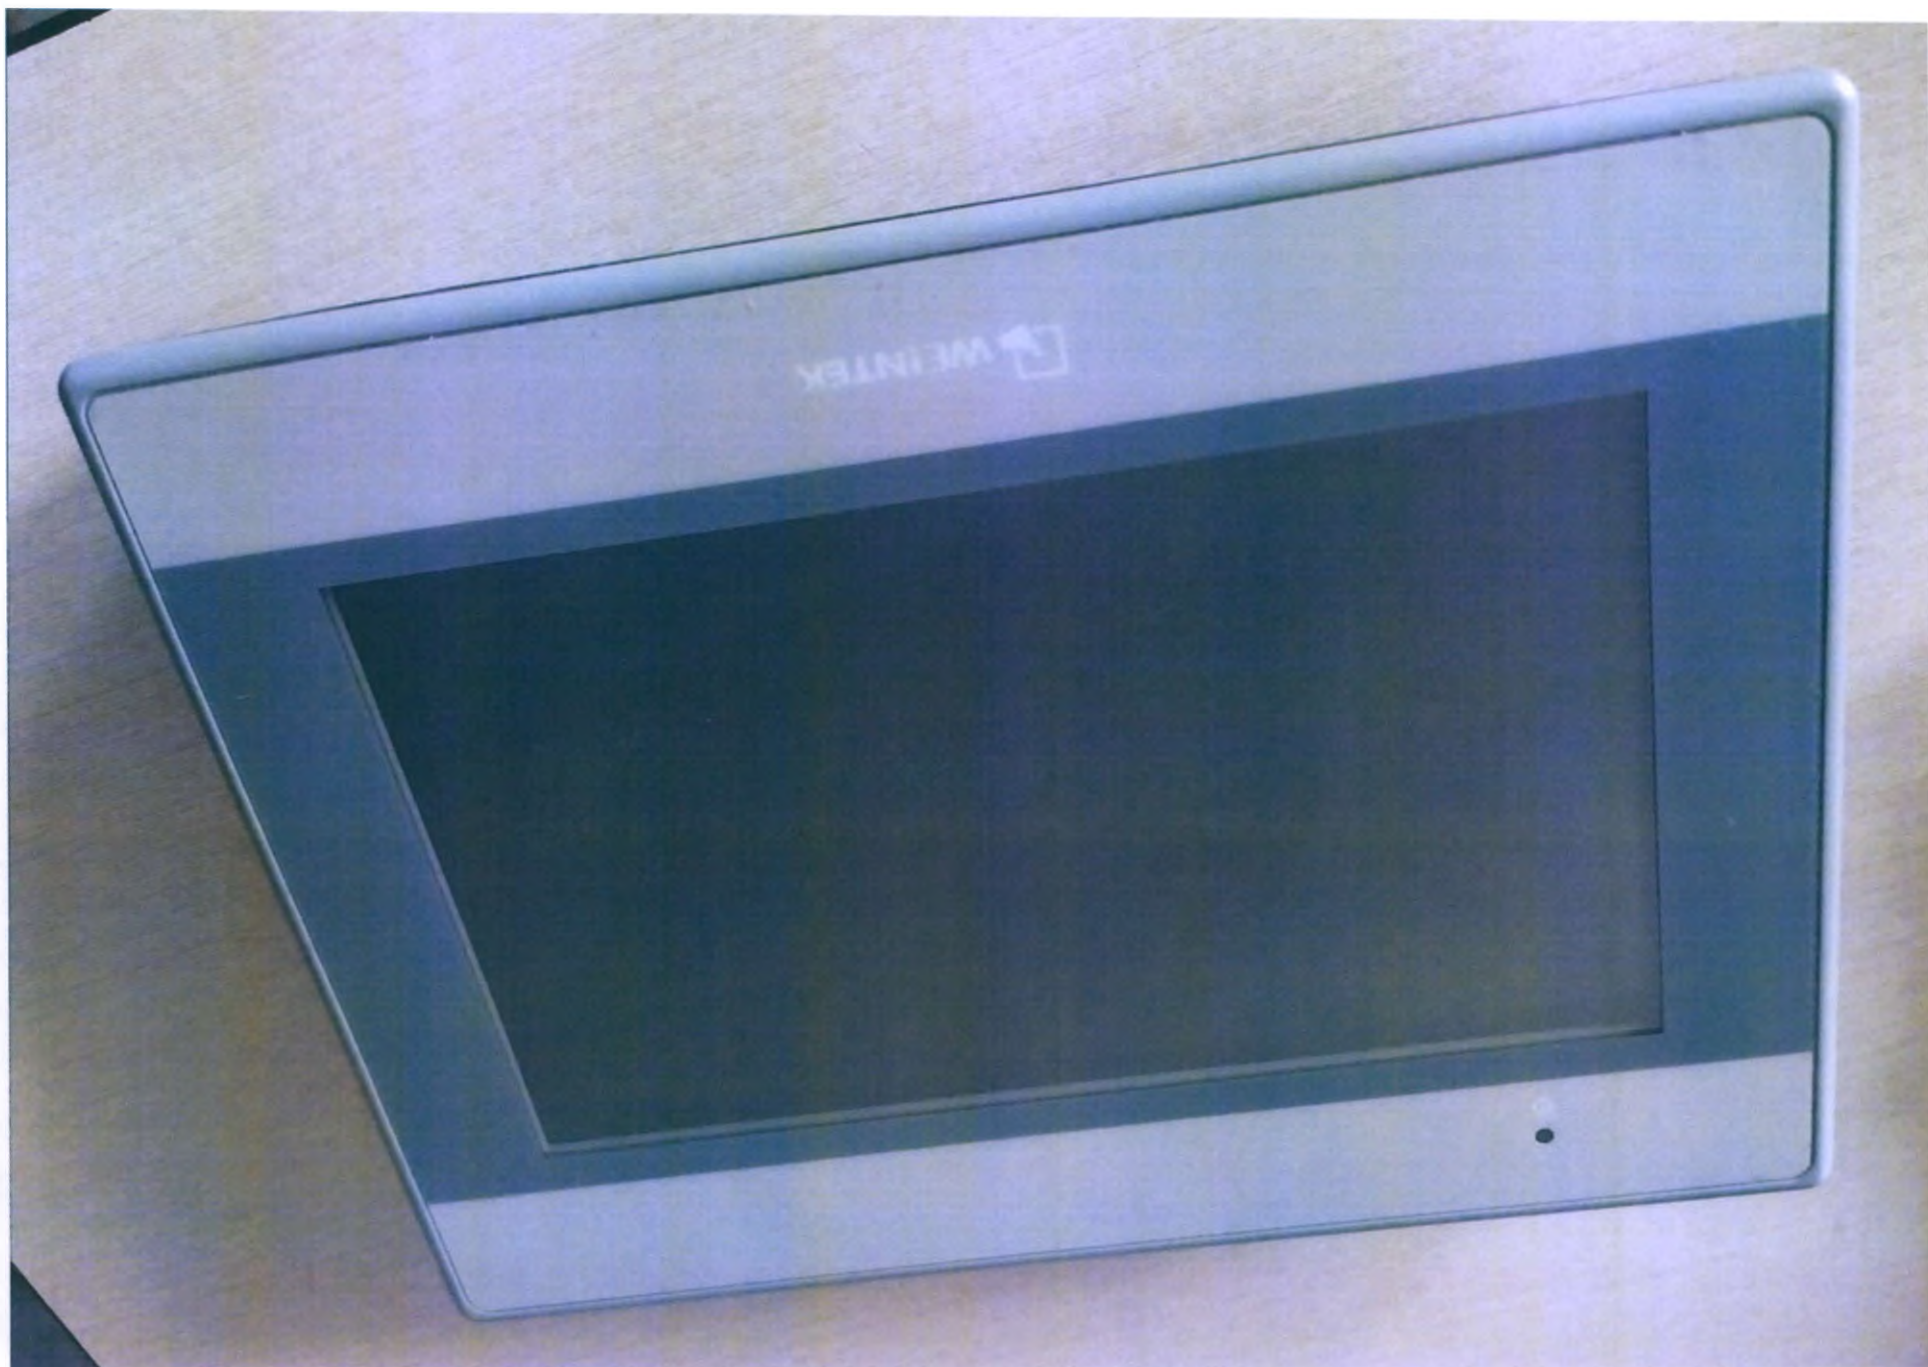

Панель управления



Парогенератор (встроенный, для исполнений DGM-100 – DGM 1500)

или



Парогенератор (внешний, для исполнений DGM-130 – DGM-2000)

или




Парогенератор (внешний, для исполнений DGM-600 – DGM-2000)


ИЛИ




Парогенератор (внешний, для исполнений DGM-130 – DGM-2000)

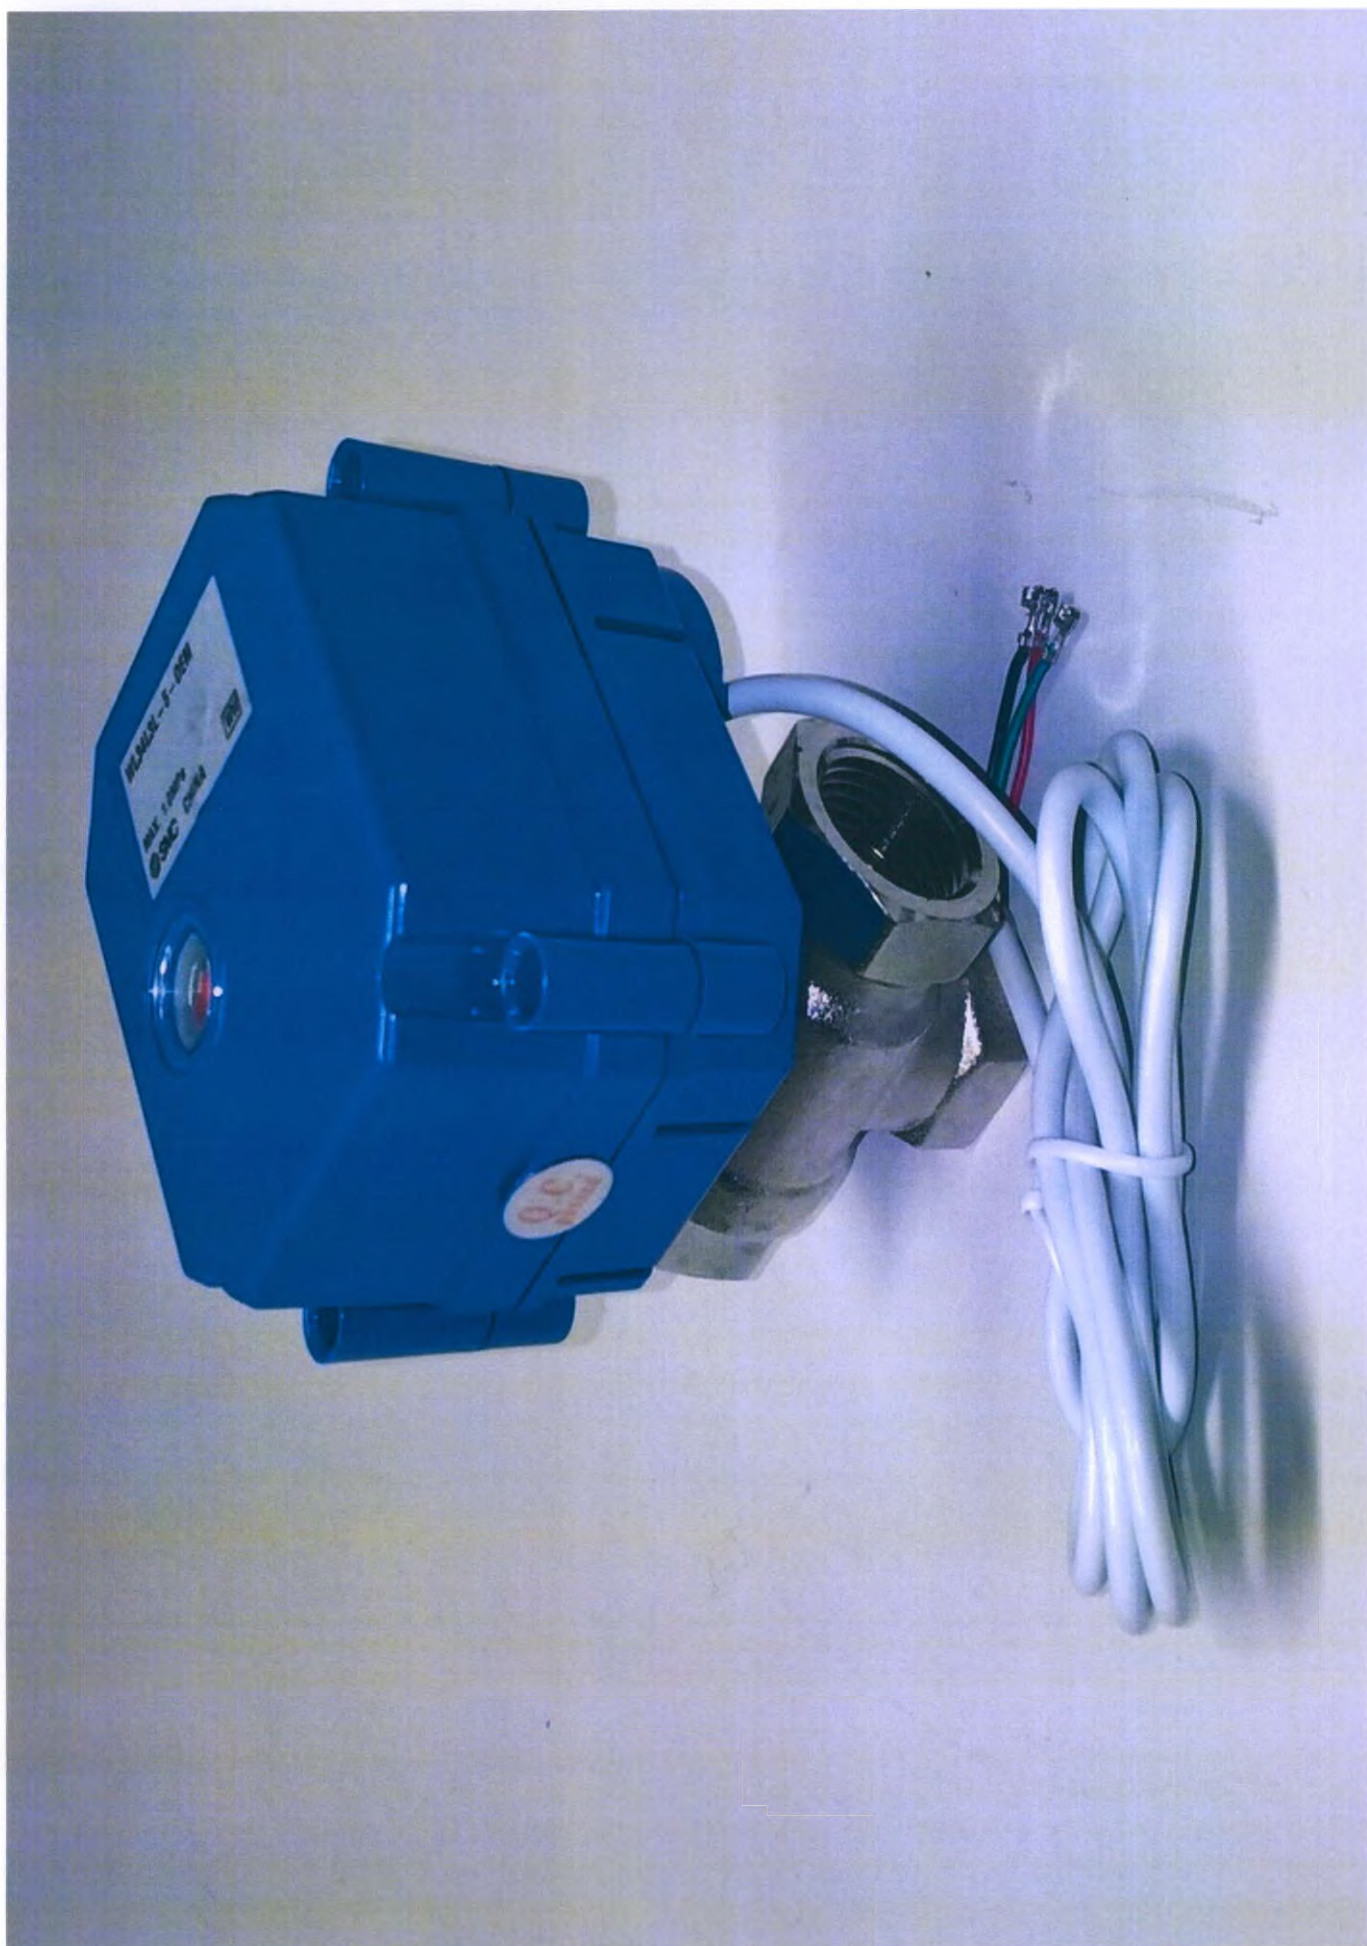


Переключатель системы уплотнения дверей

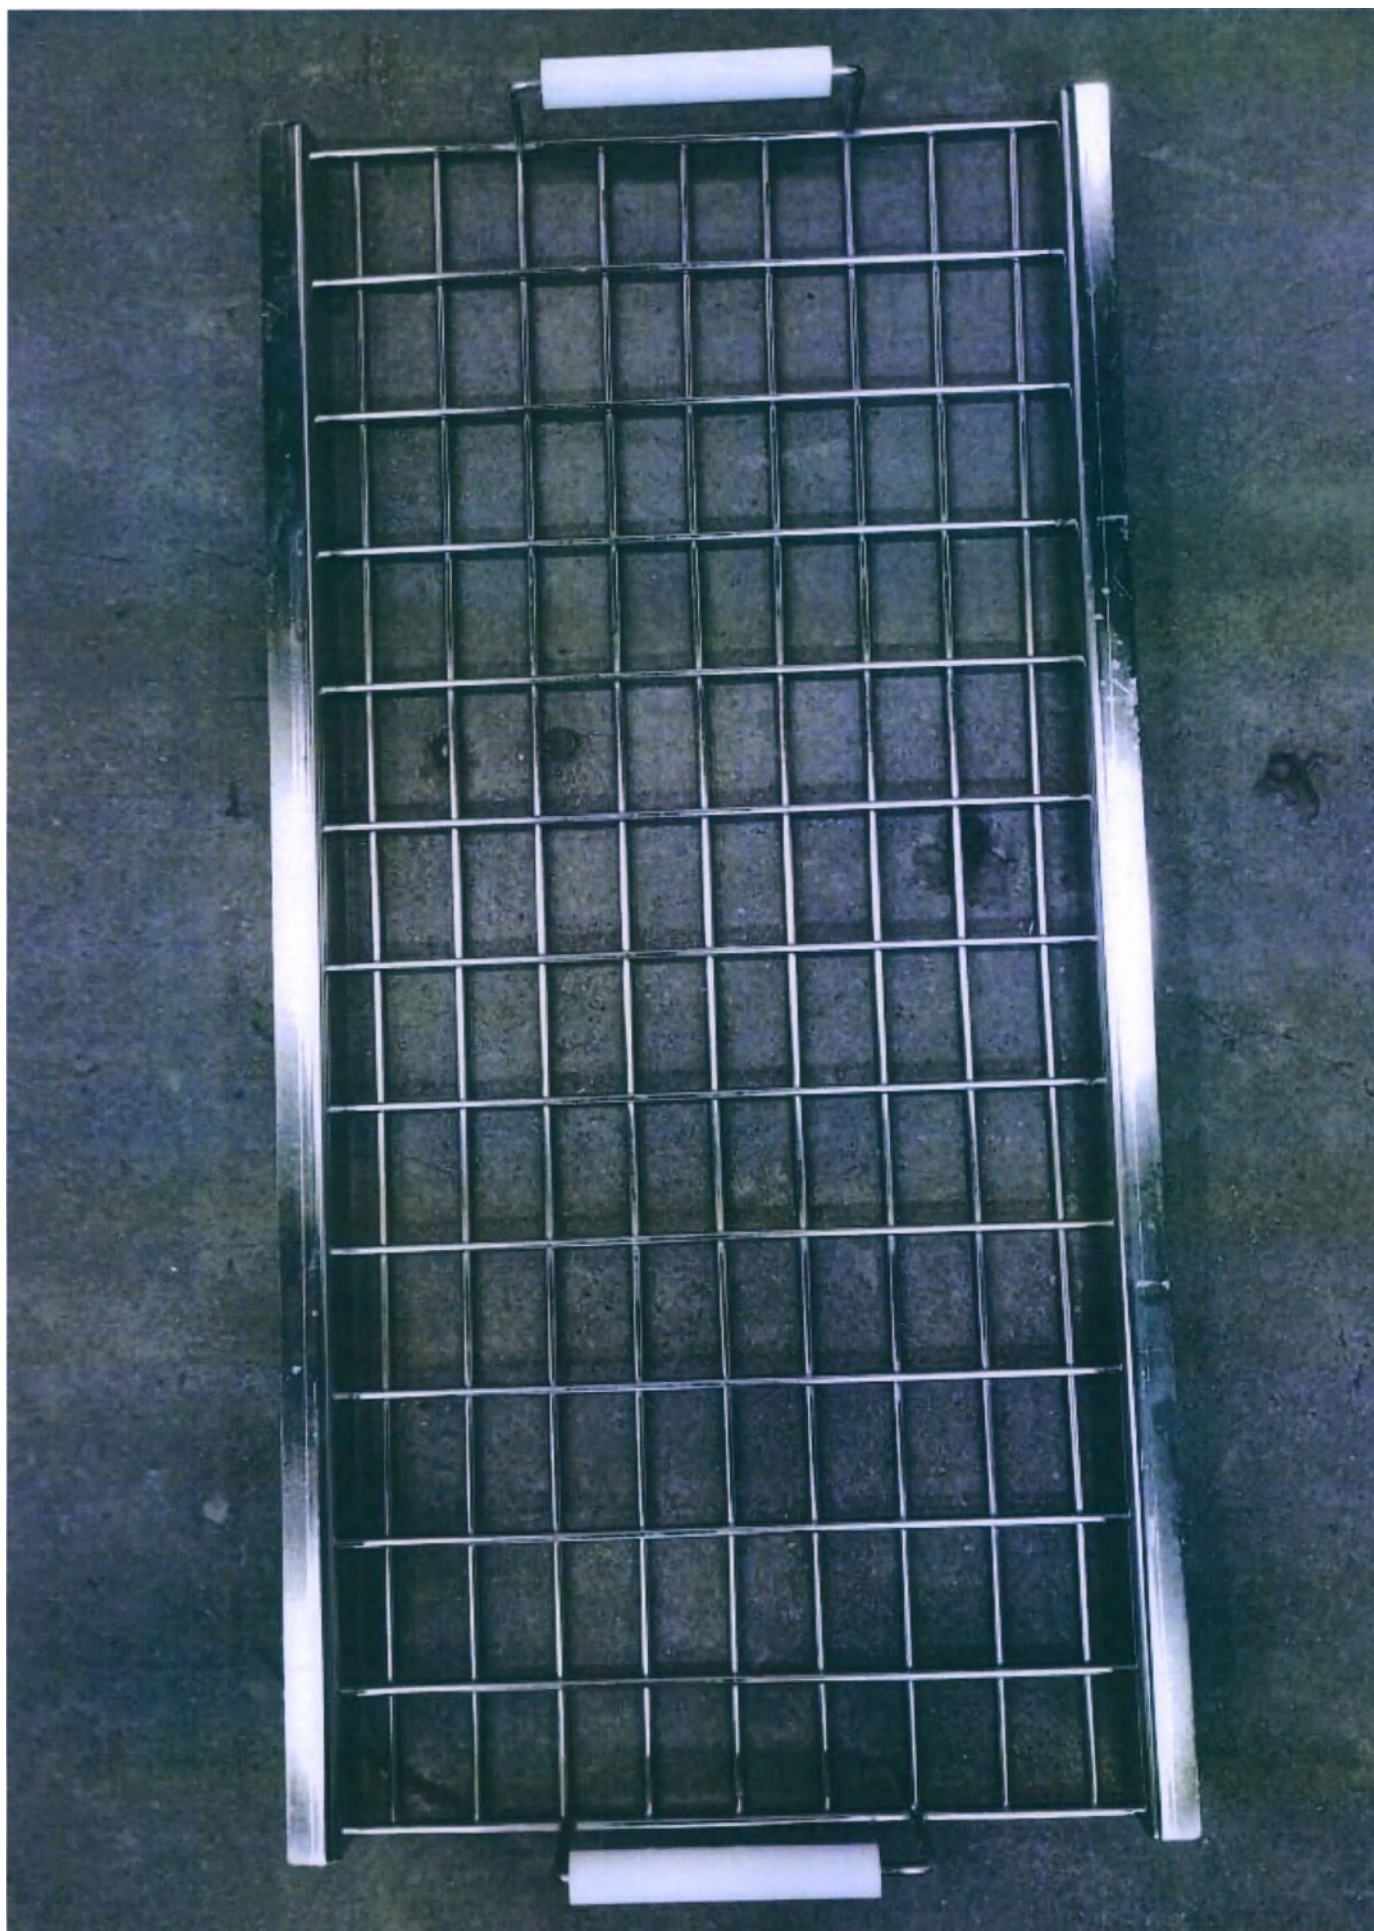


Полка камеры

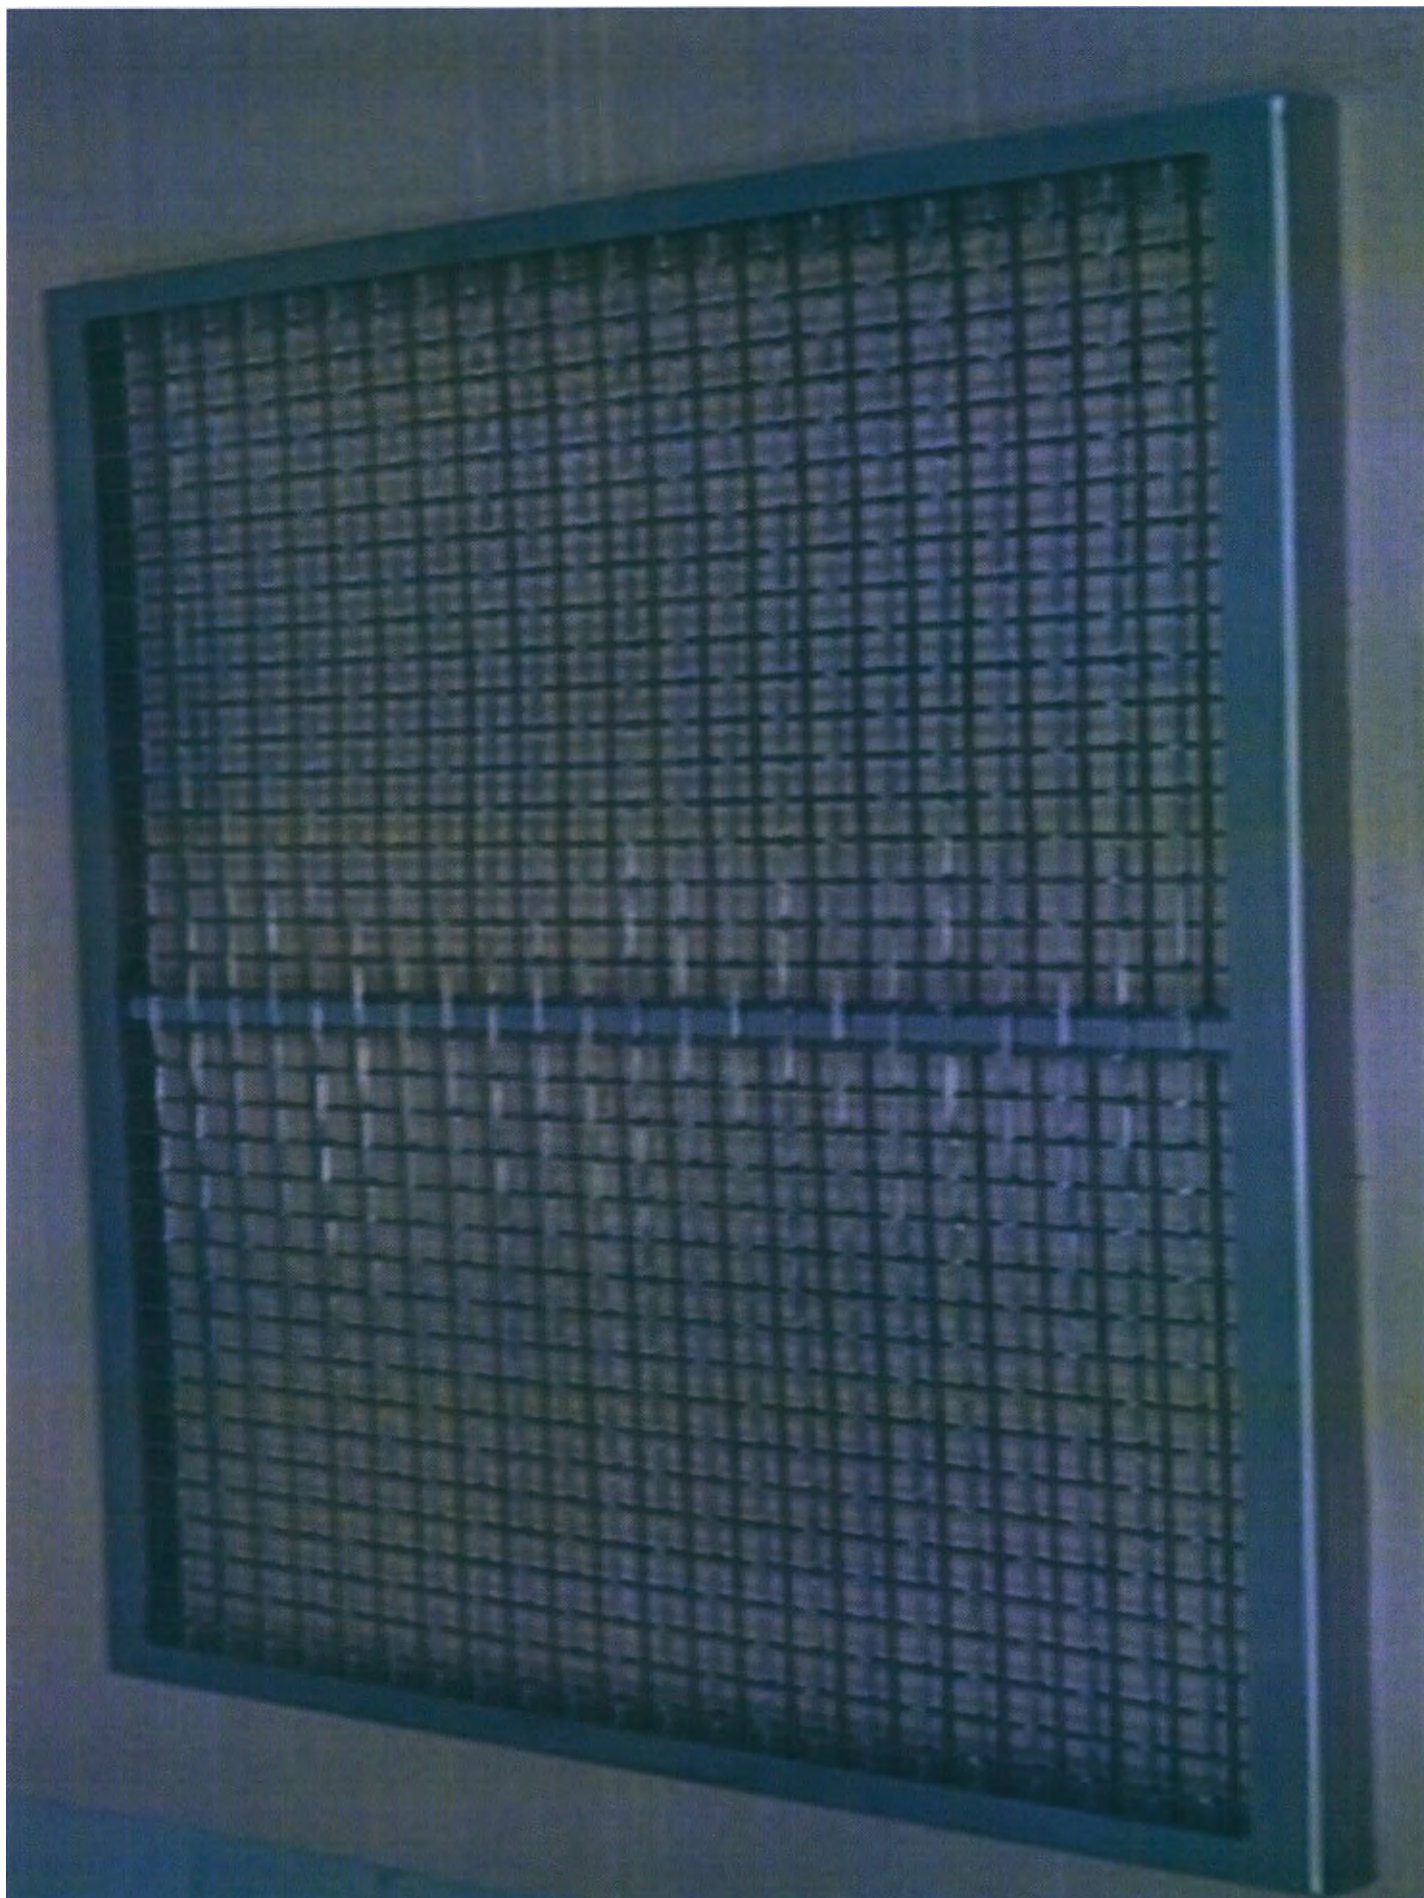


Полка тележки

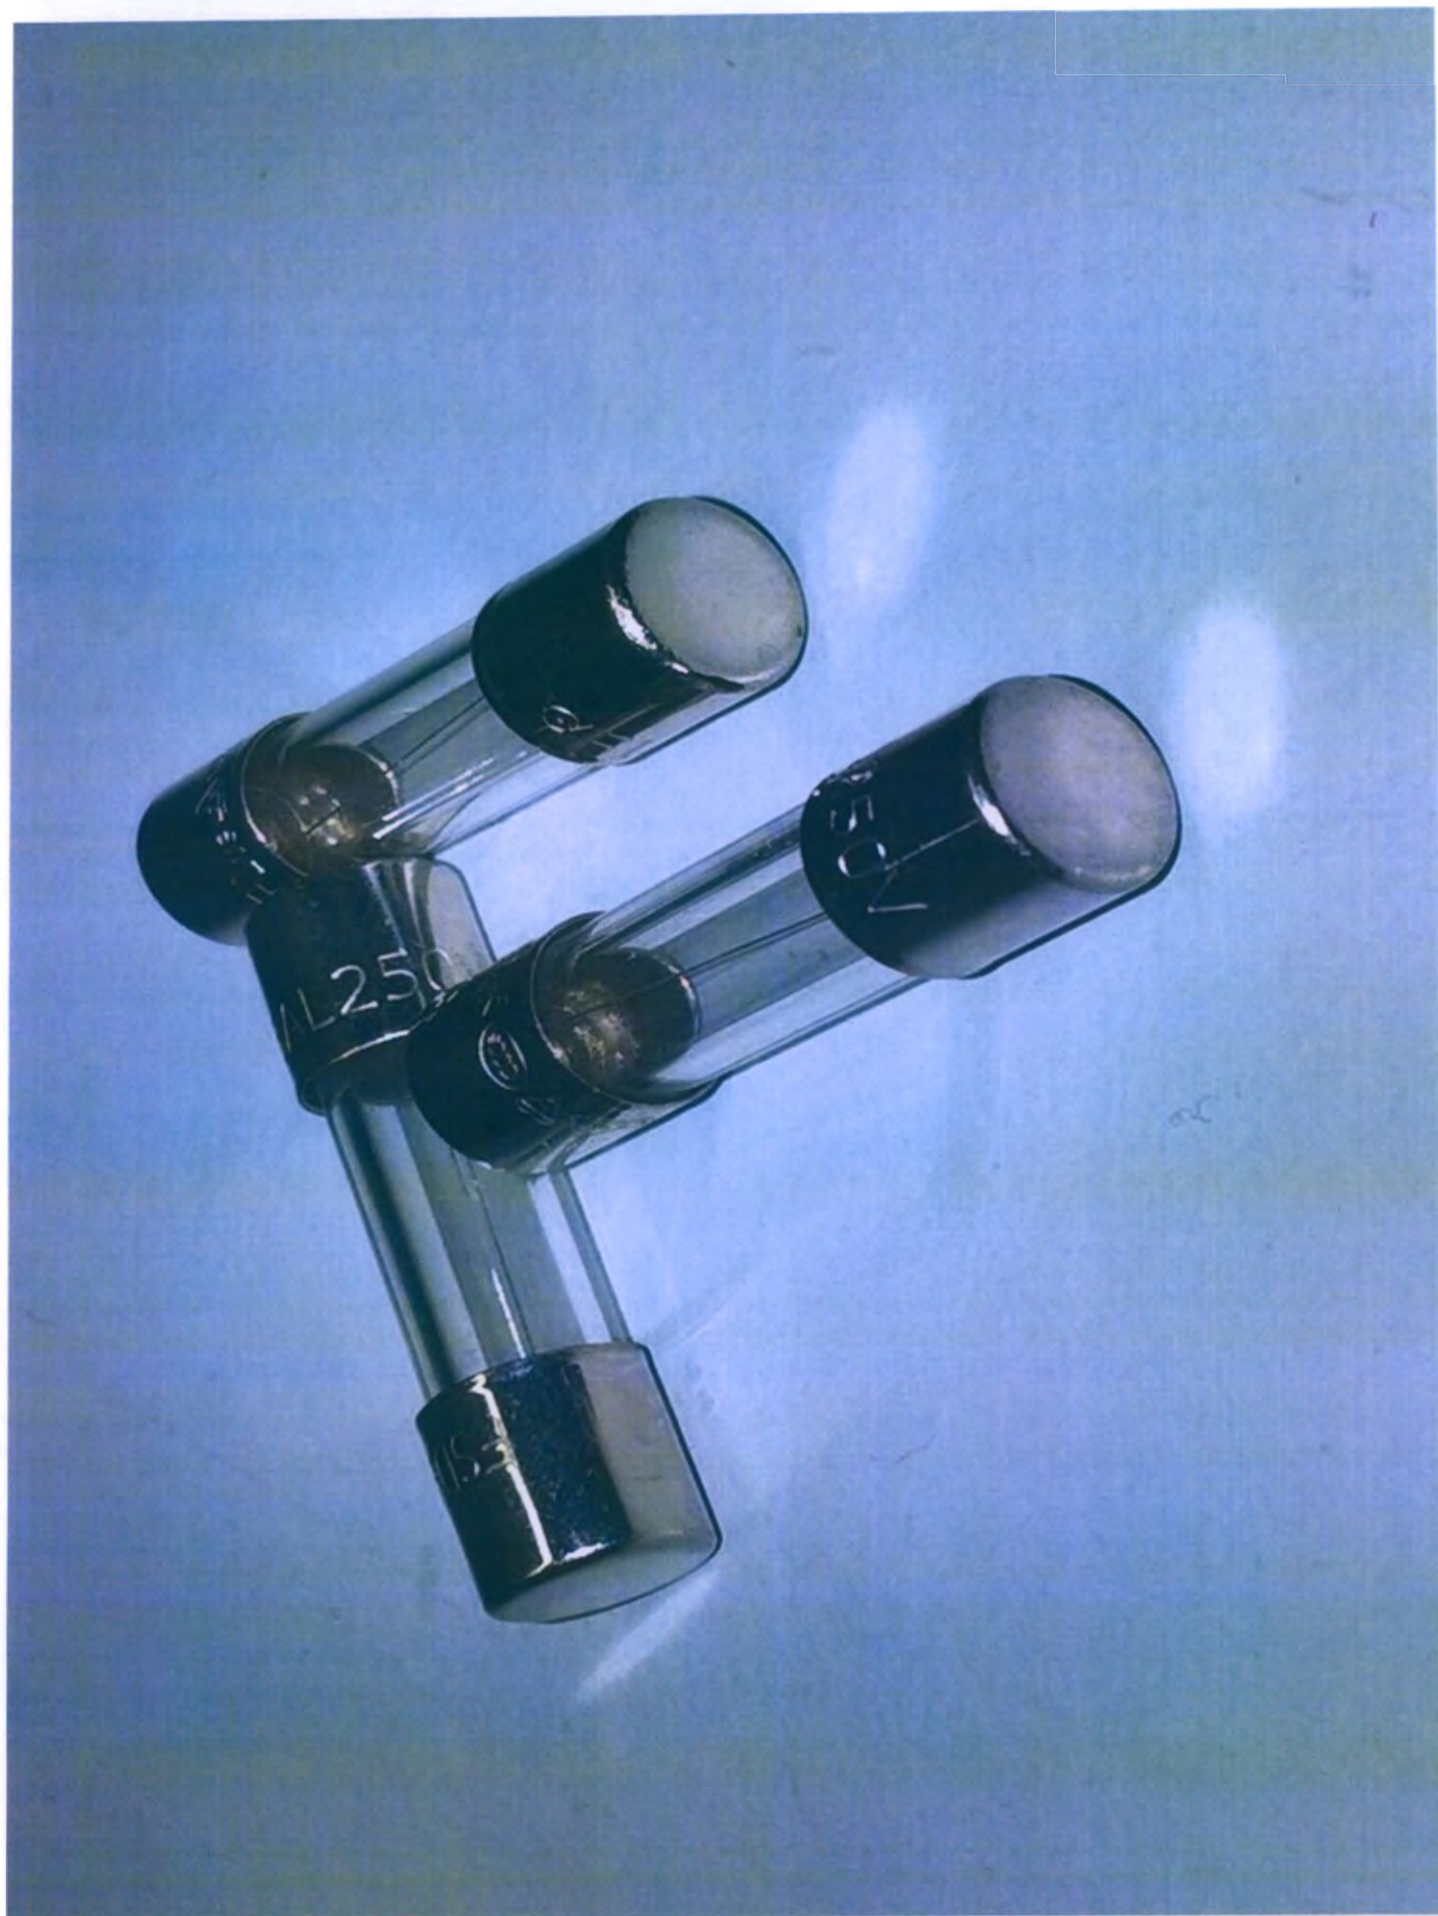


Предохранитель плавкий

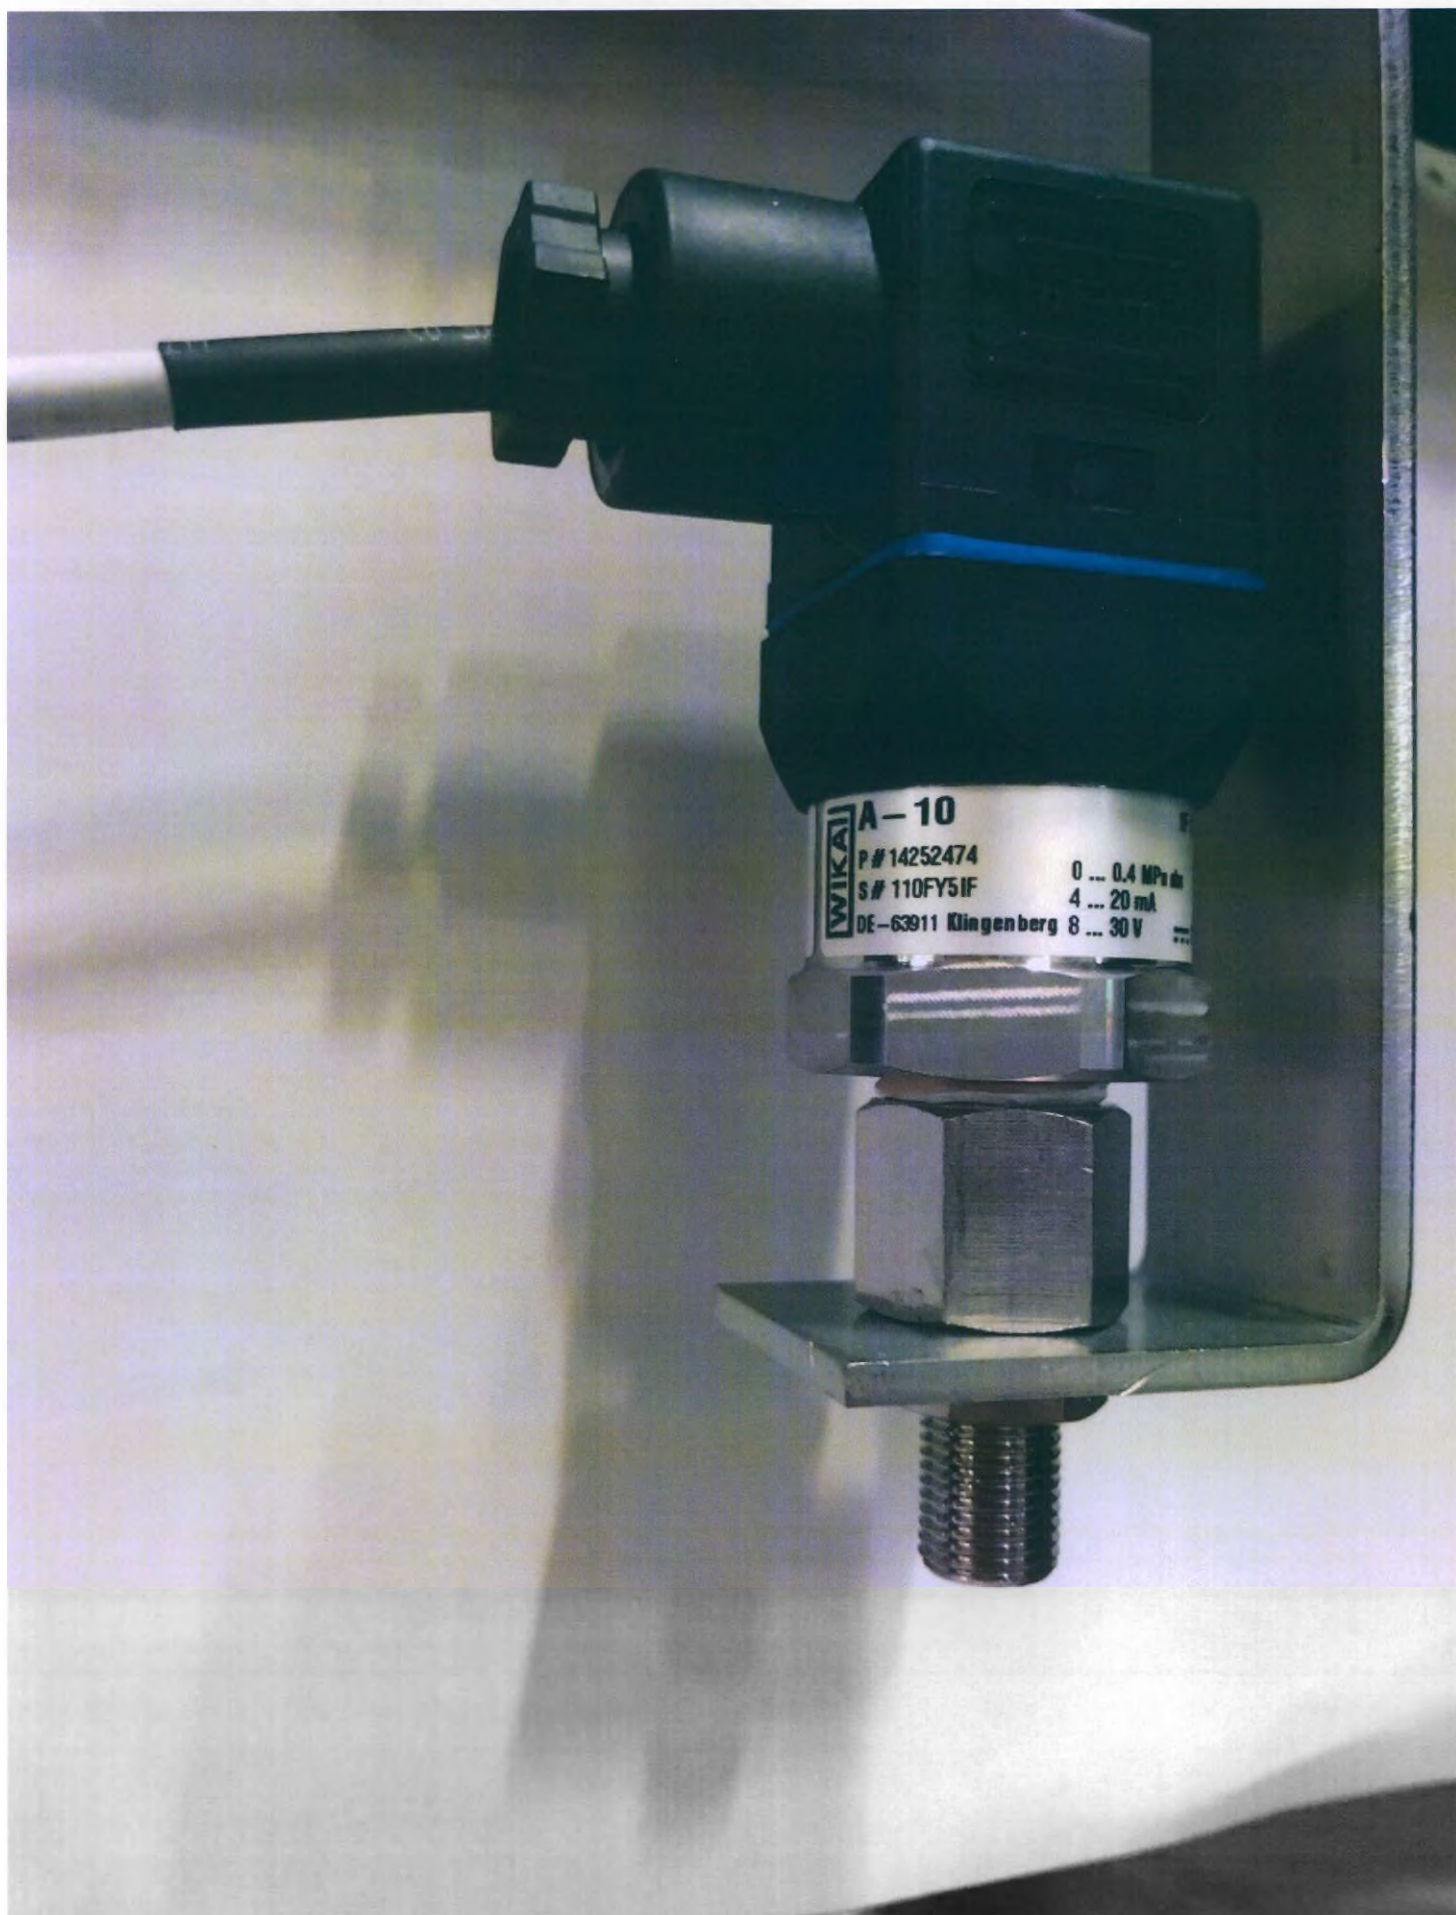

Преобразователь давления

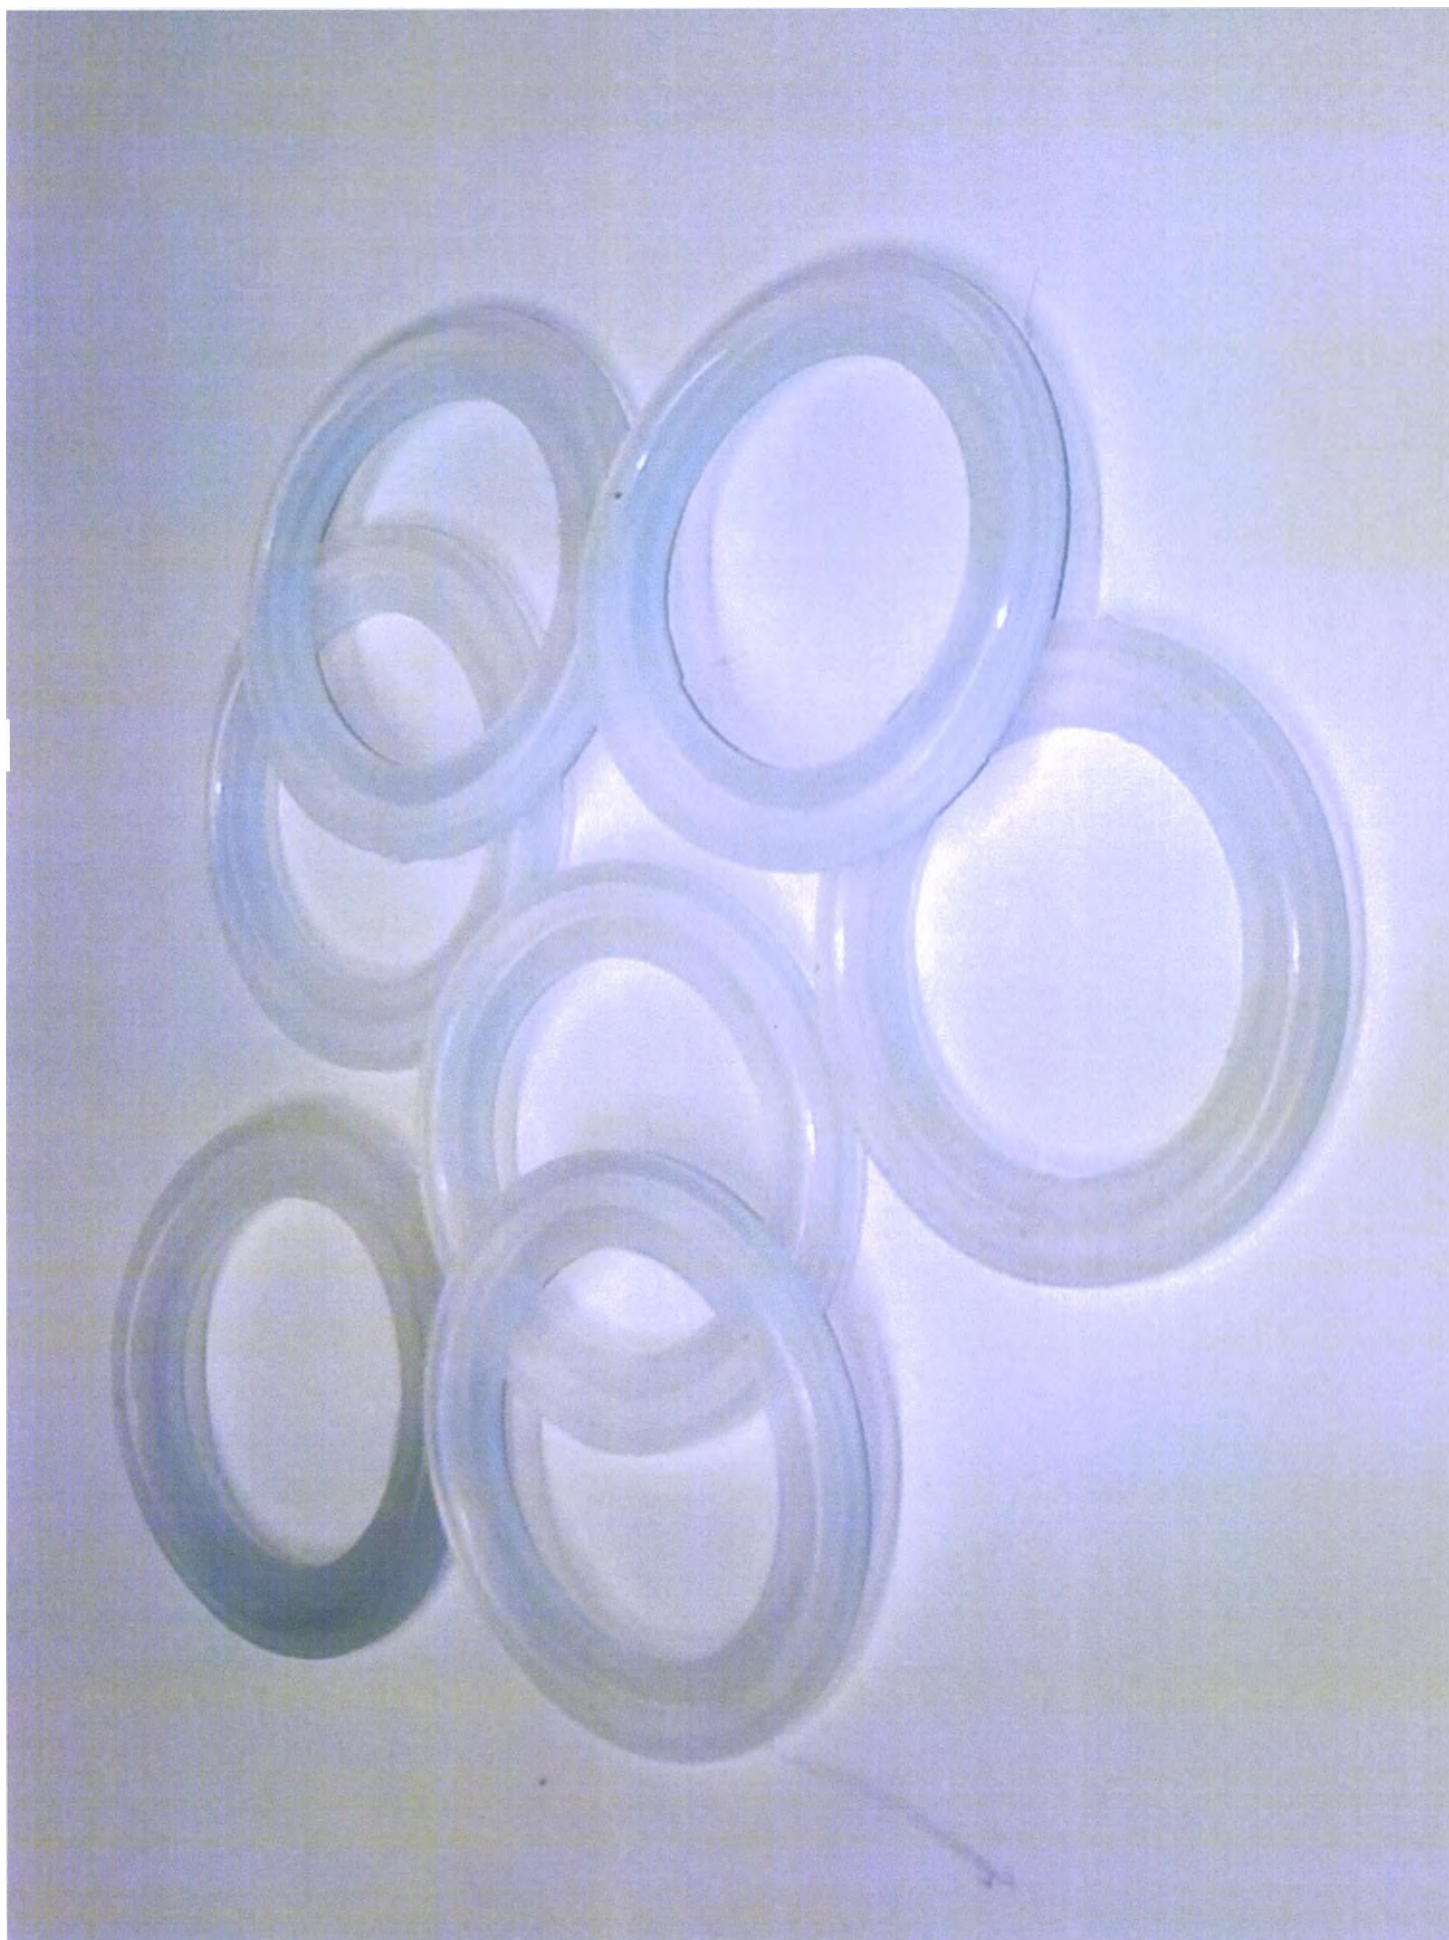

Прокладка уплотнительная для соединений типа “tri-clamp”

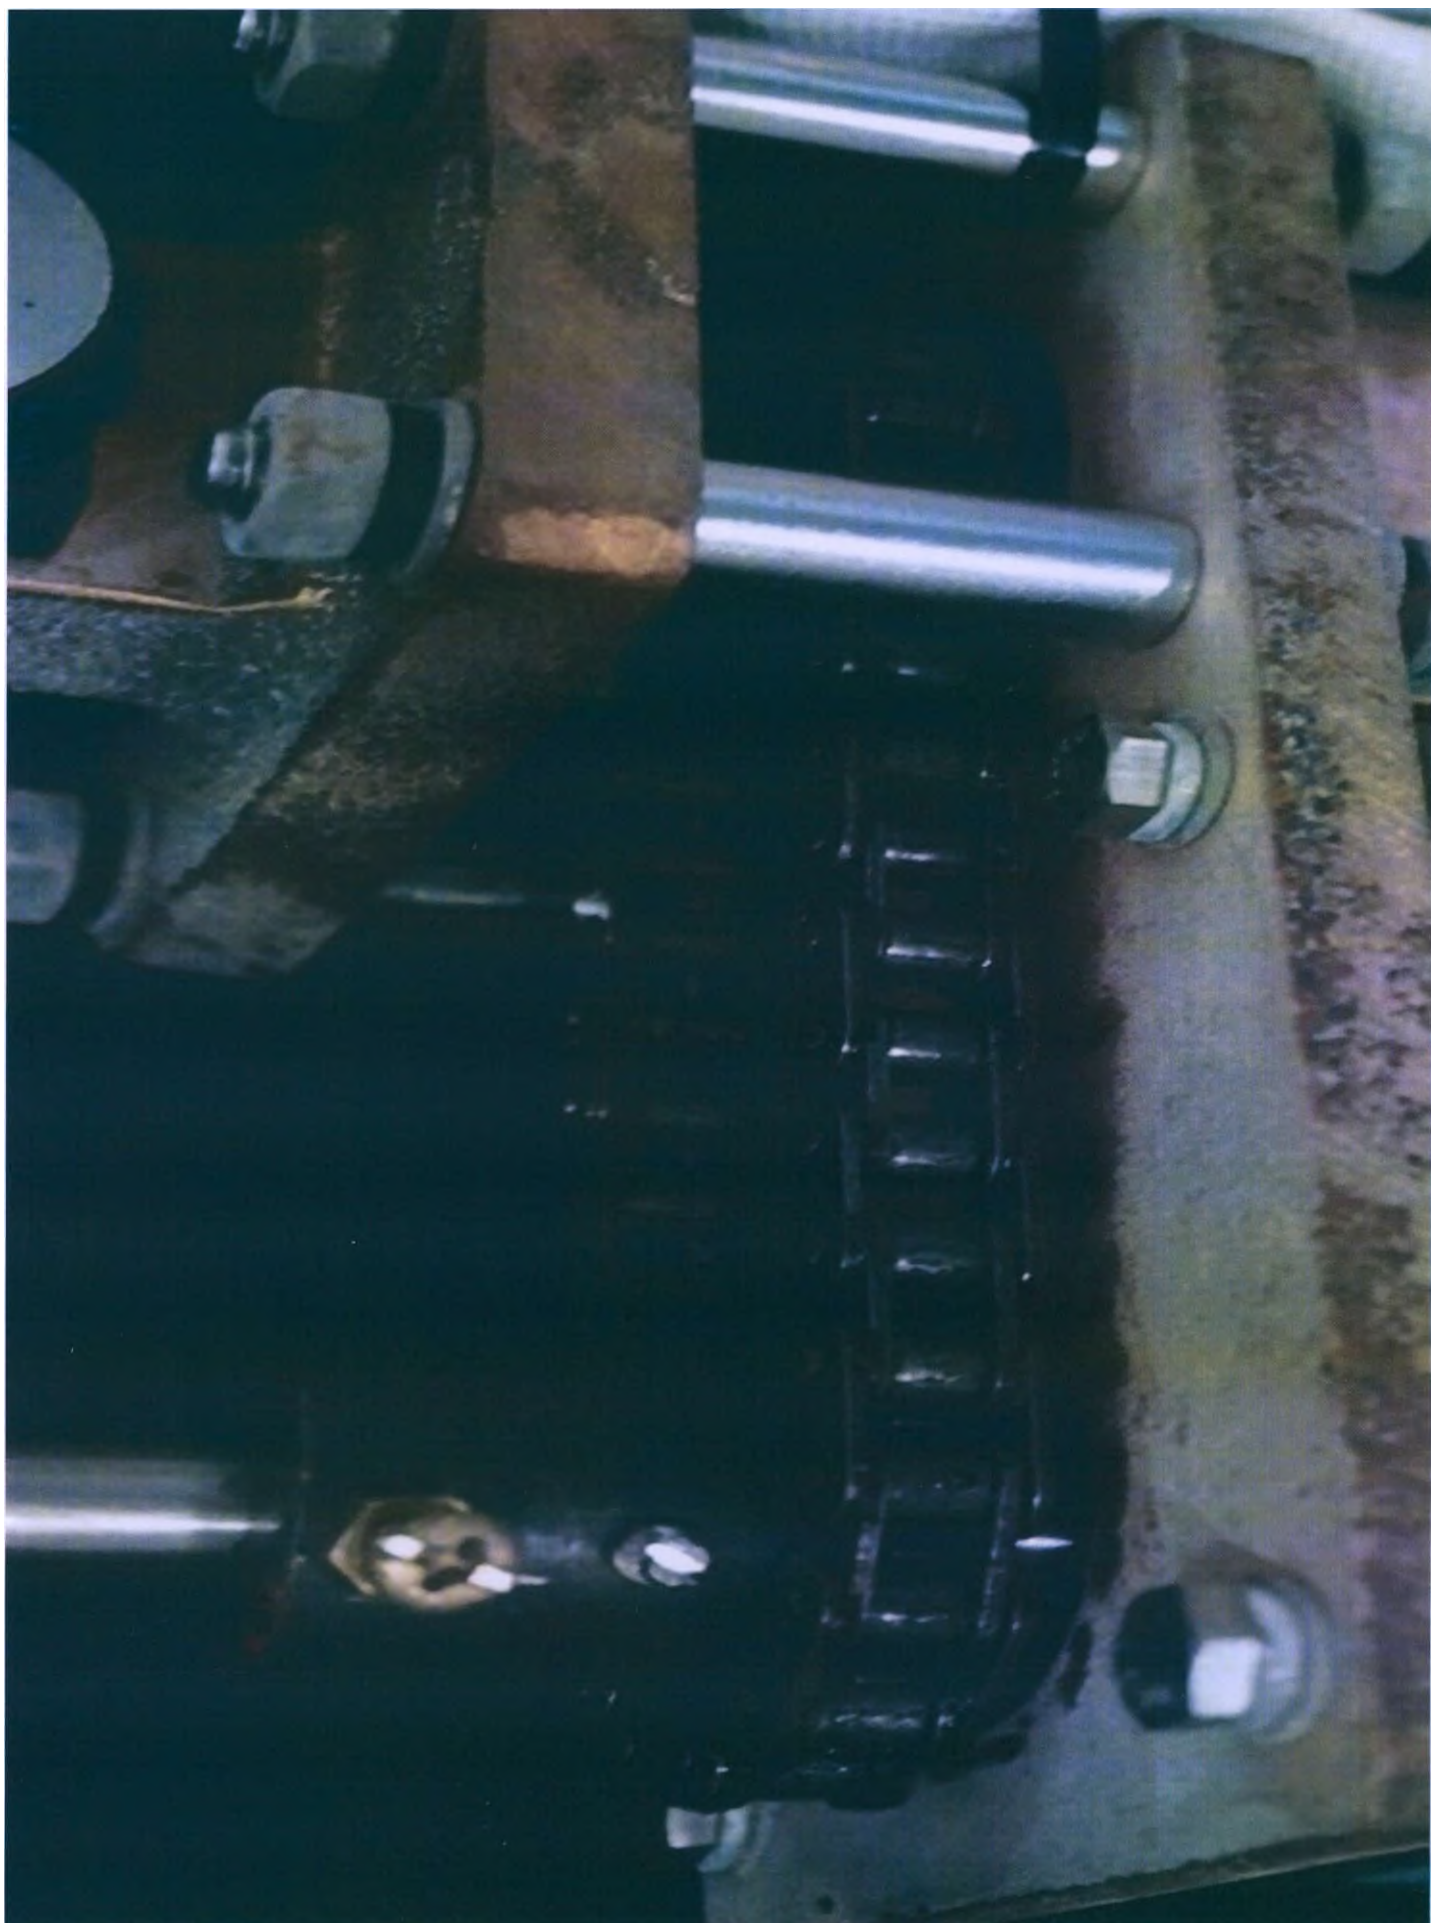

Привод механизма закрытия двери





Принтер встроенный




Регистратор электронный технологический ВОДОЛЕЙ РЭТ-2

Регистратор nanodac

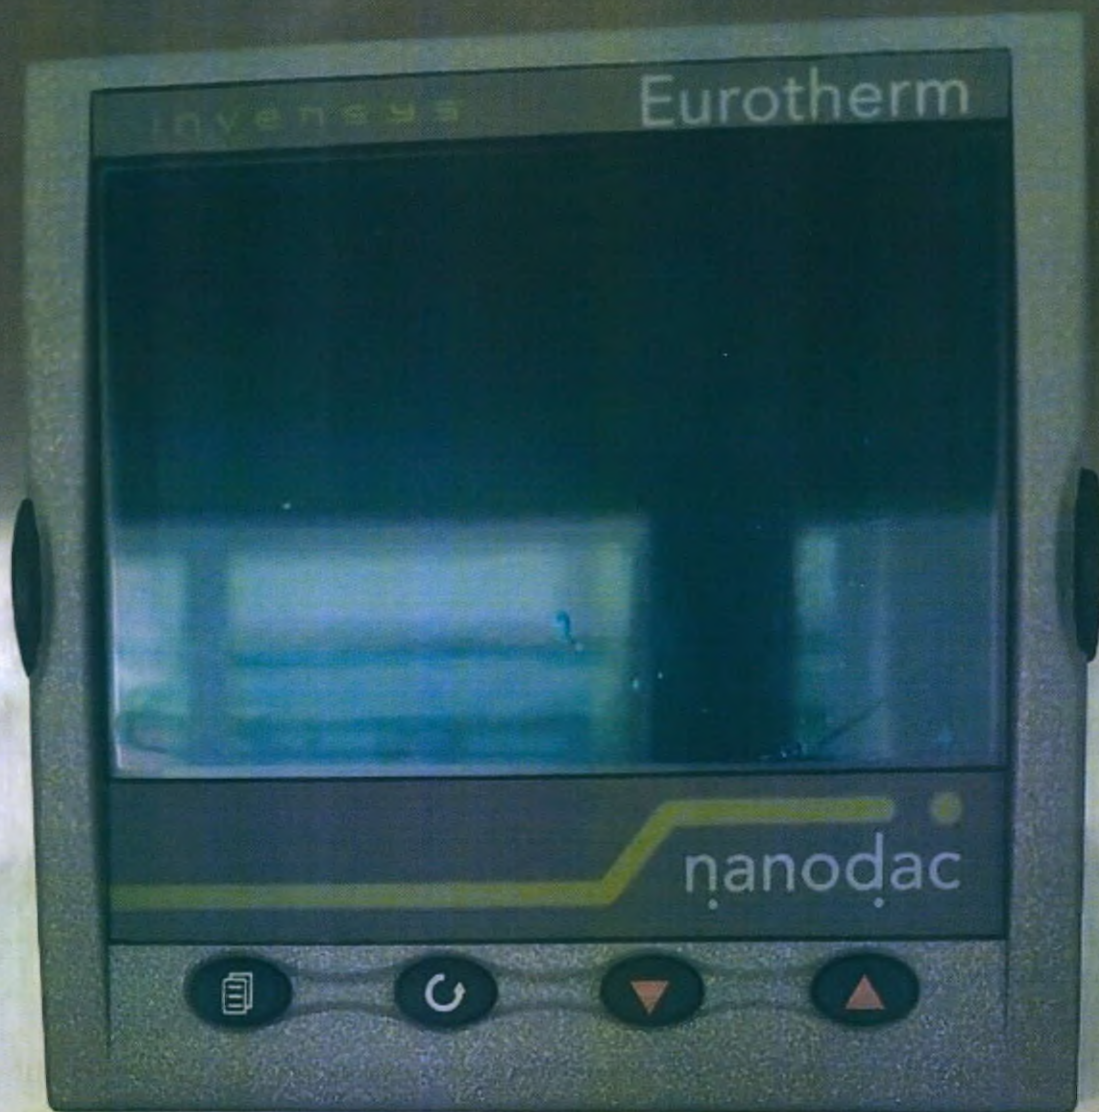


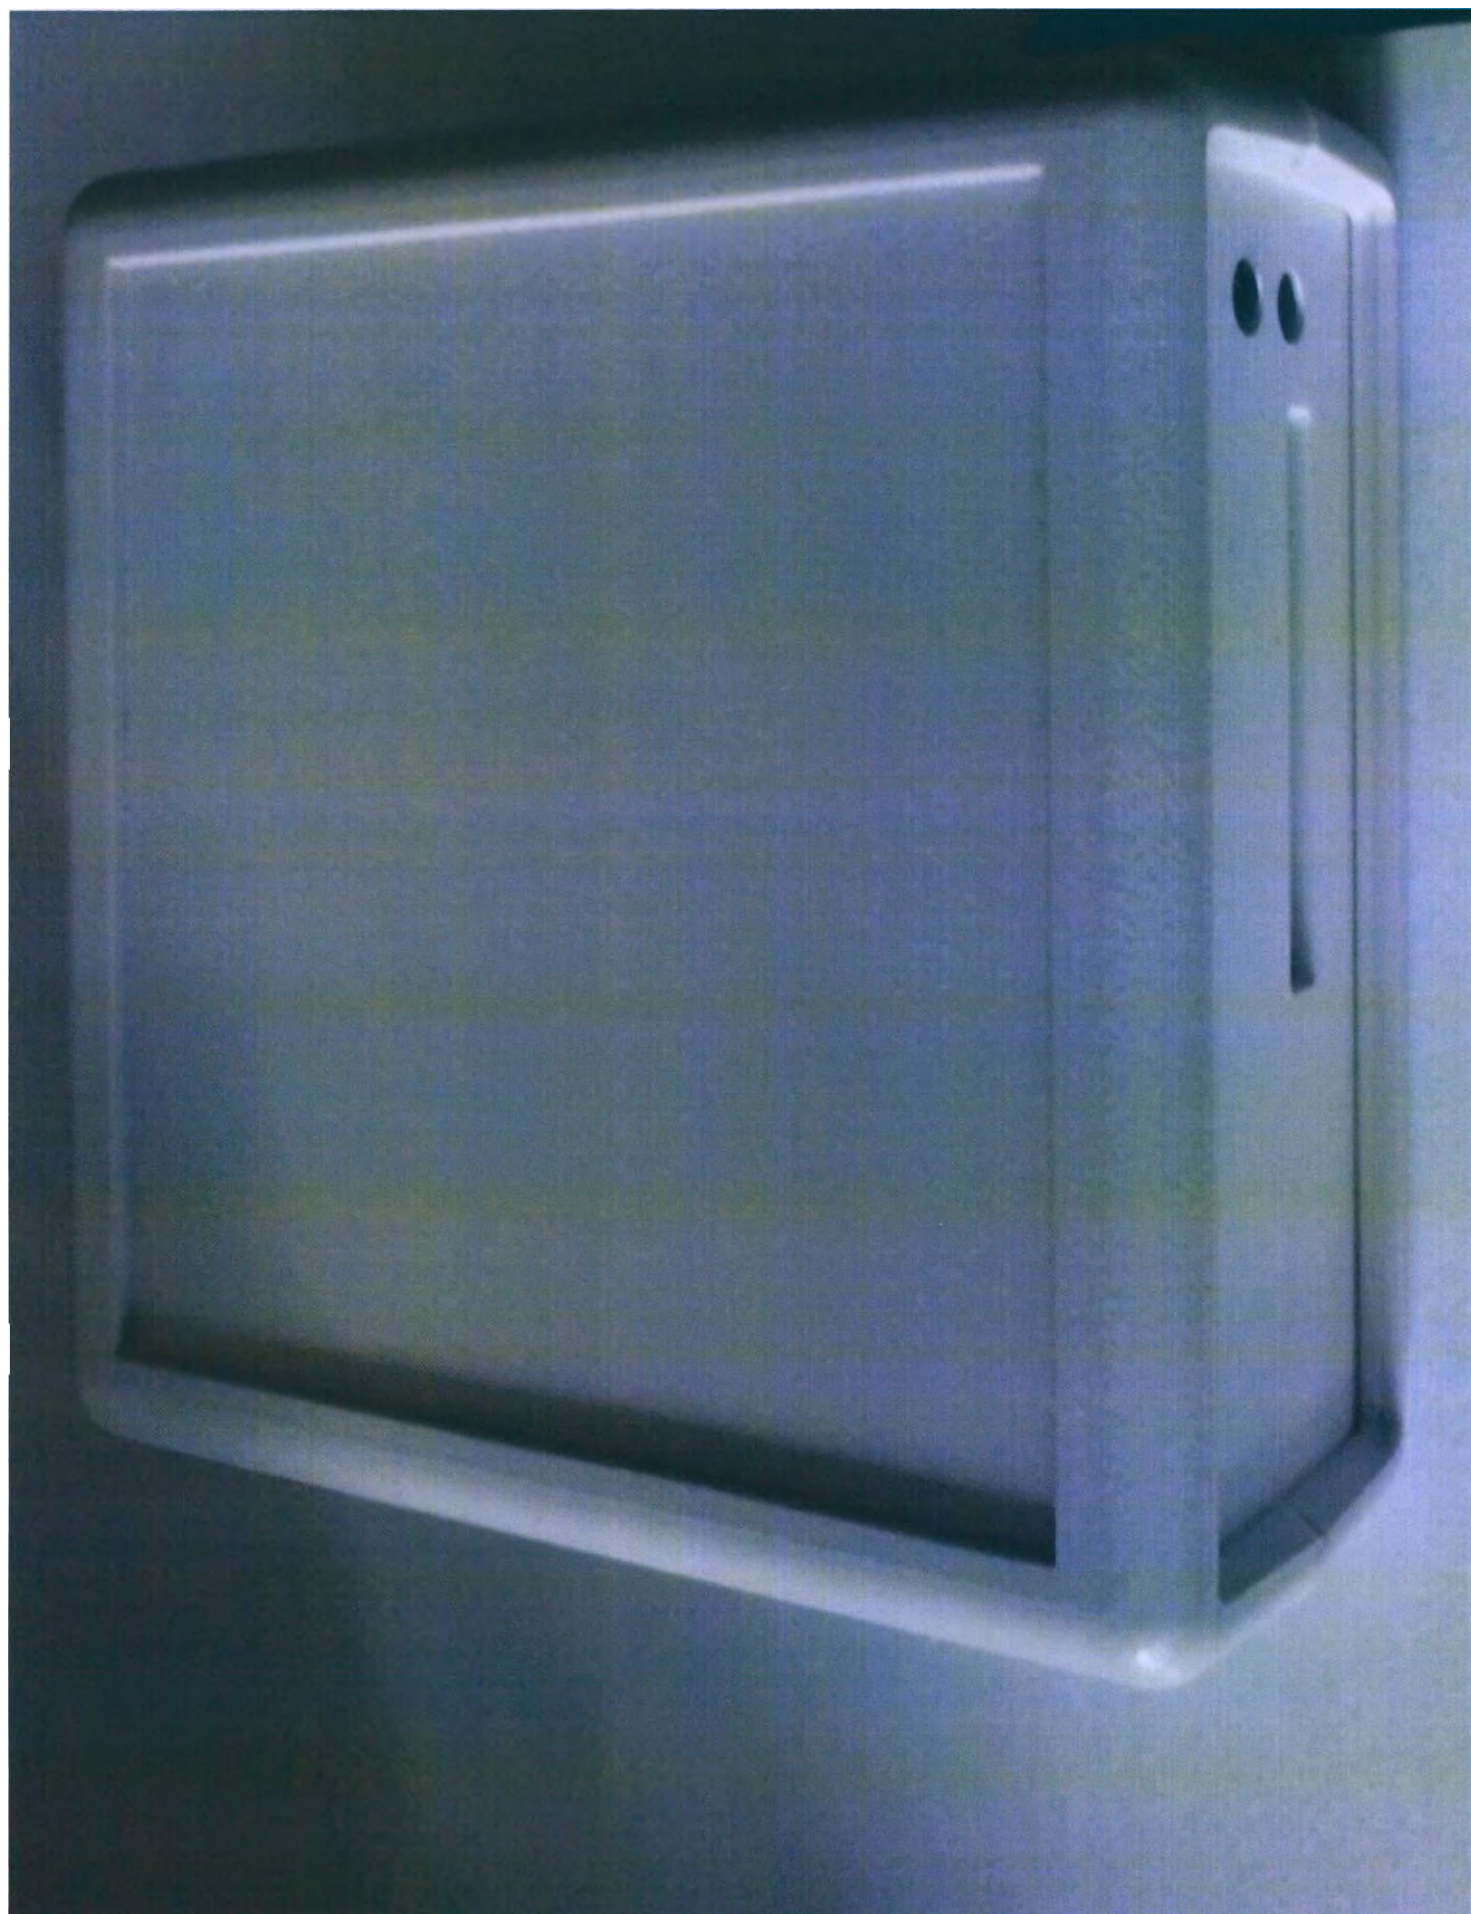

Регистратор данных (Даталоггер)

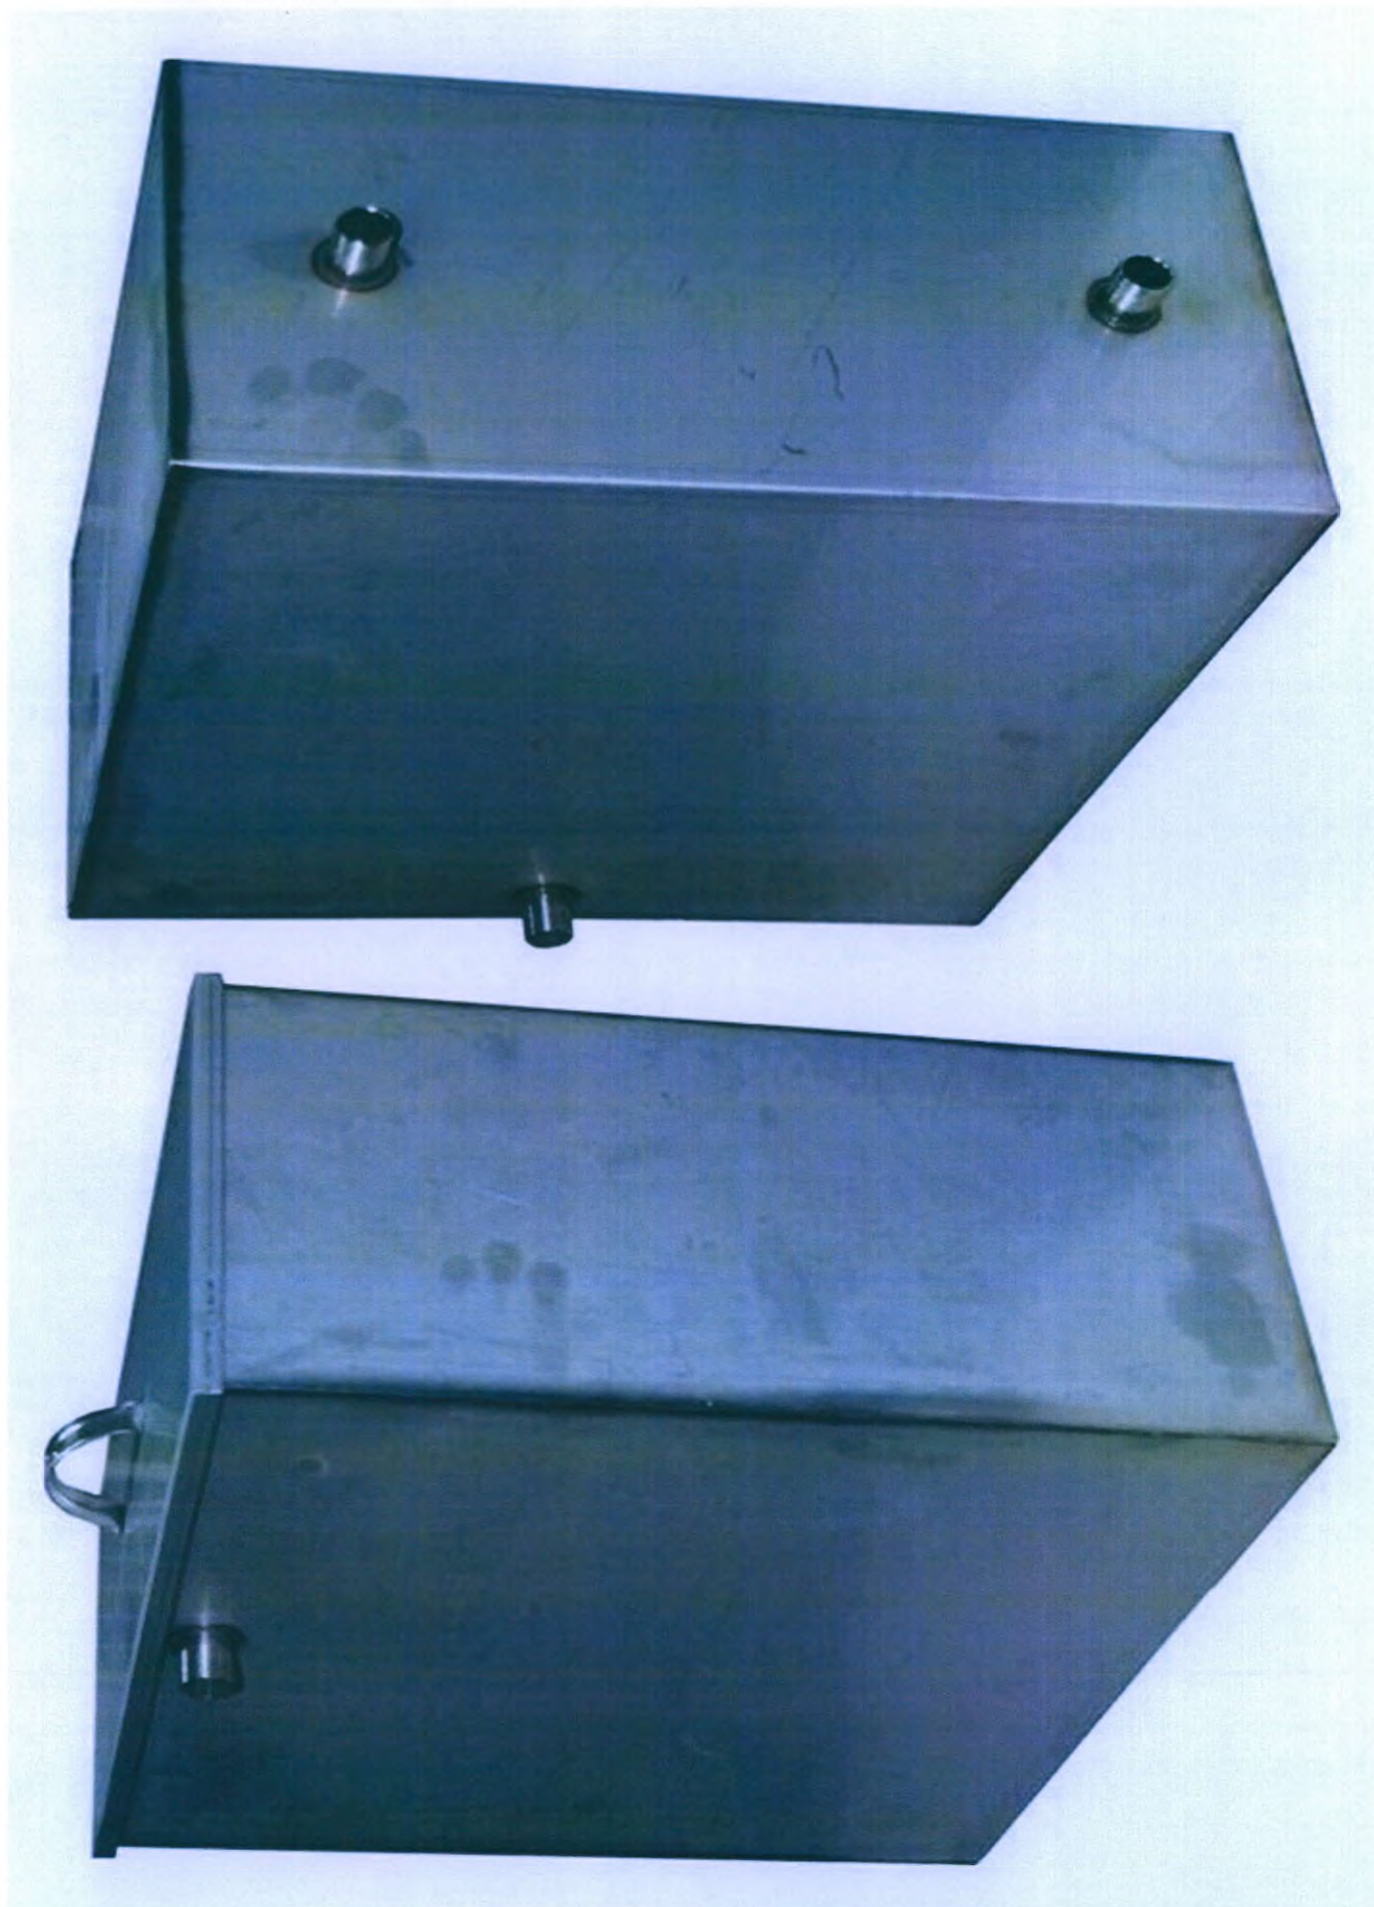

Резервуар (бачок) гидравлический

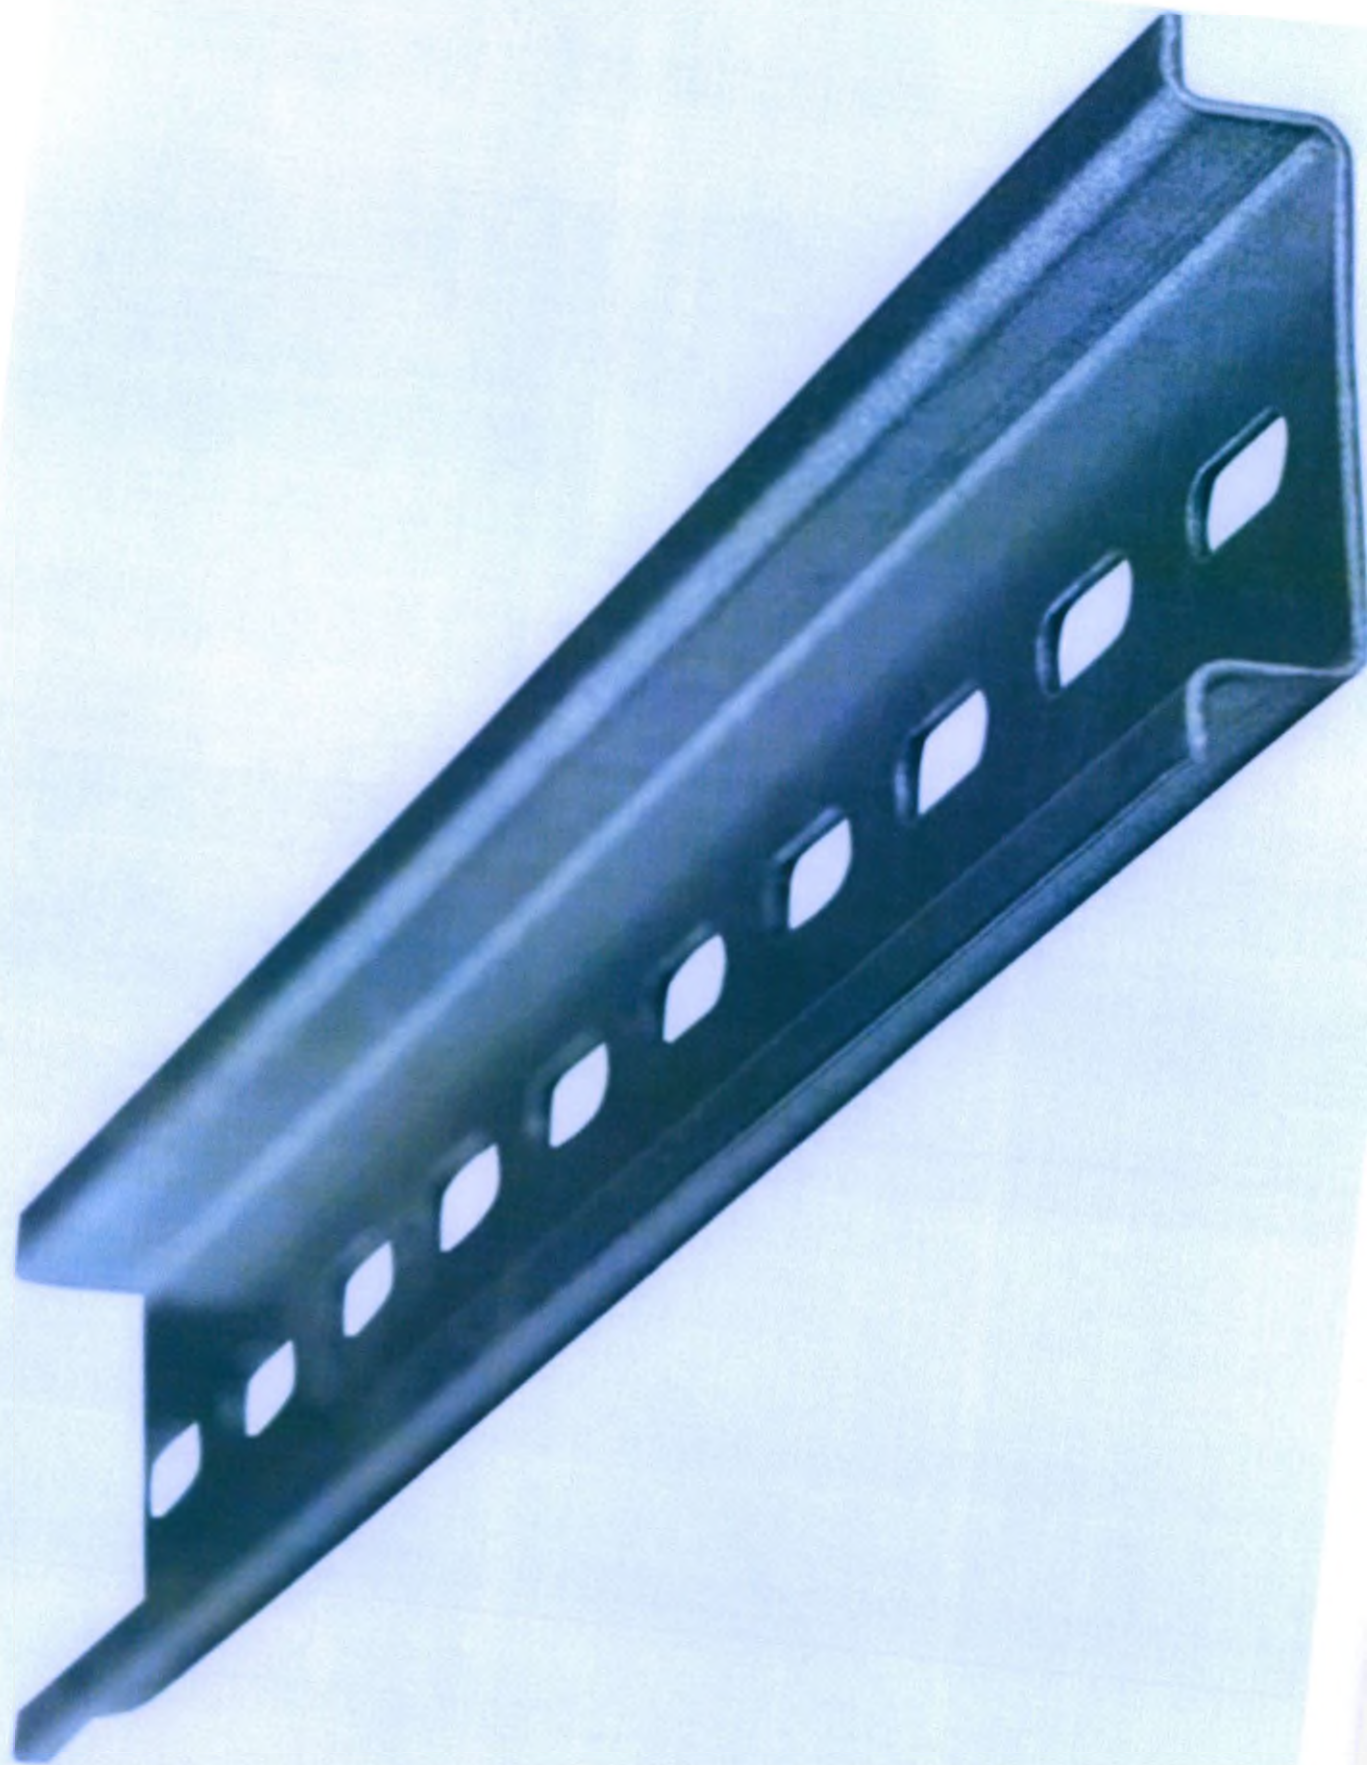

Рейка под выключатель




Реле с установочной колодкой




Реле нагревательных элементов




Реле твердотельные

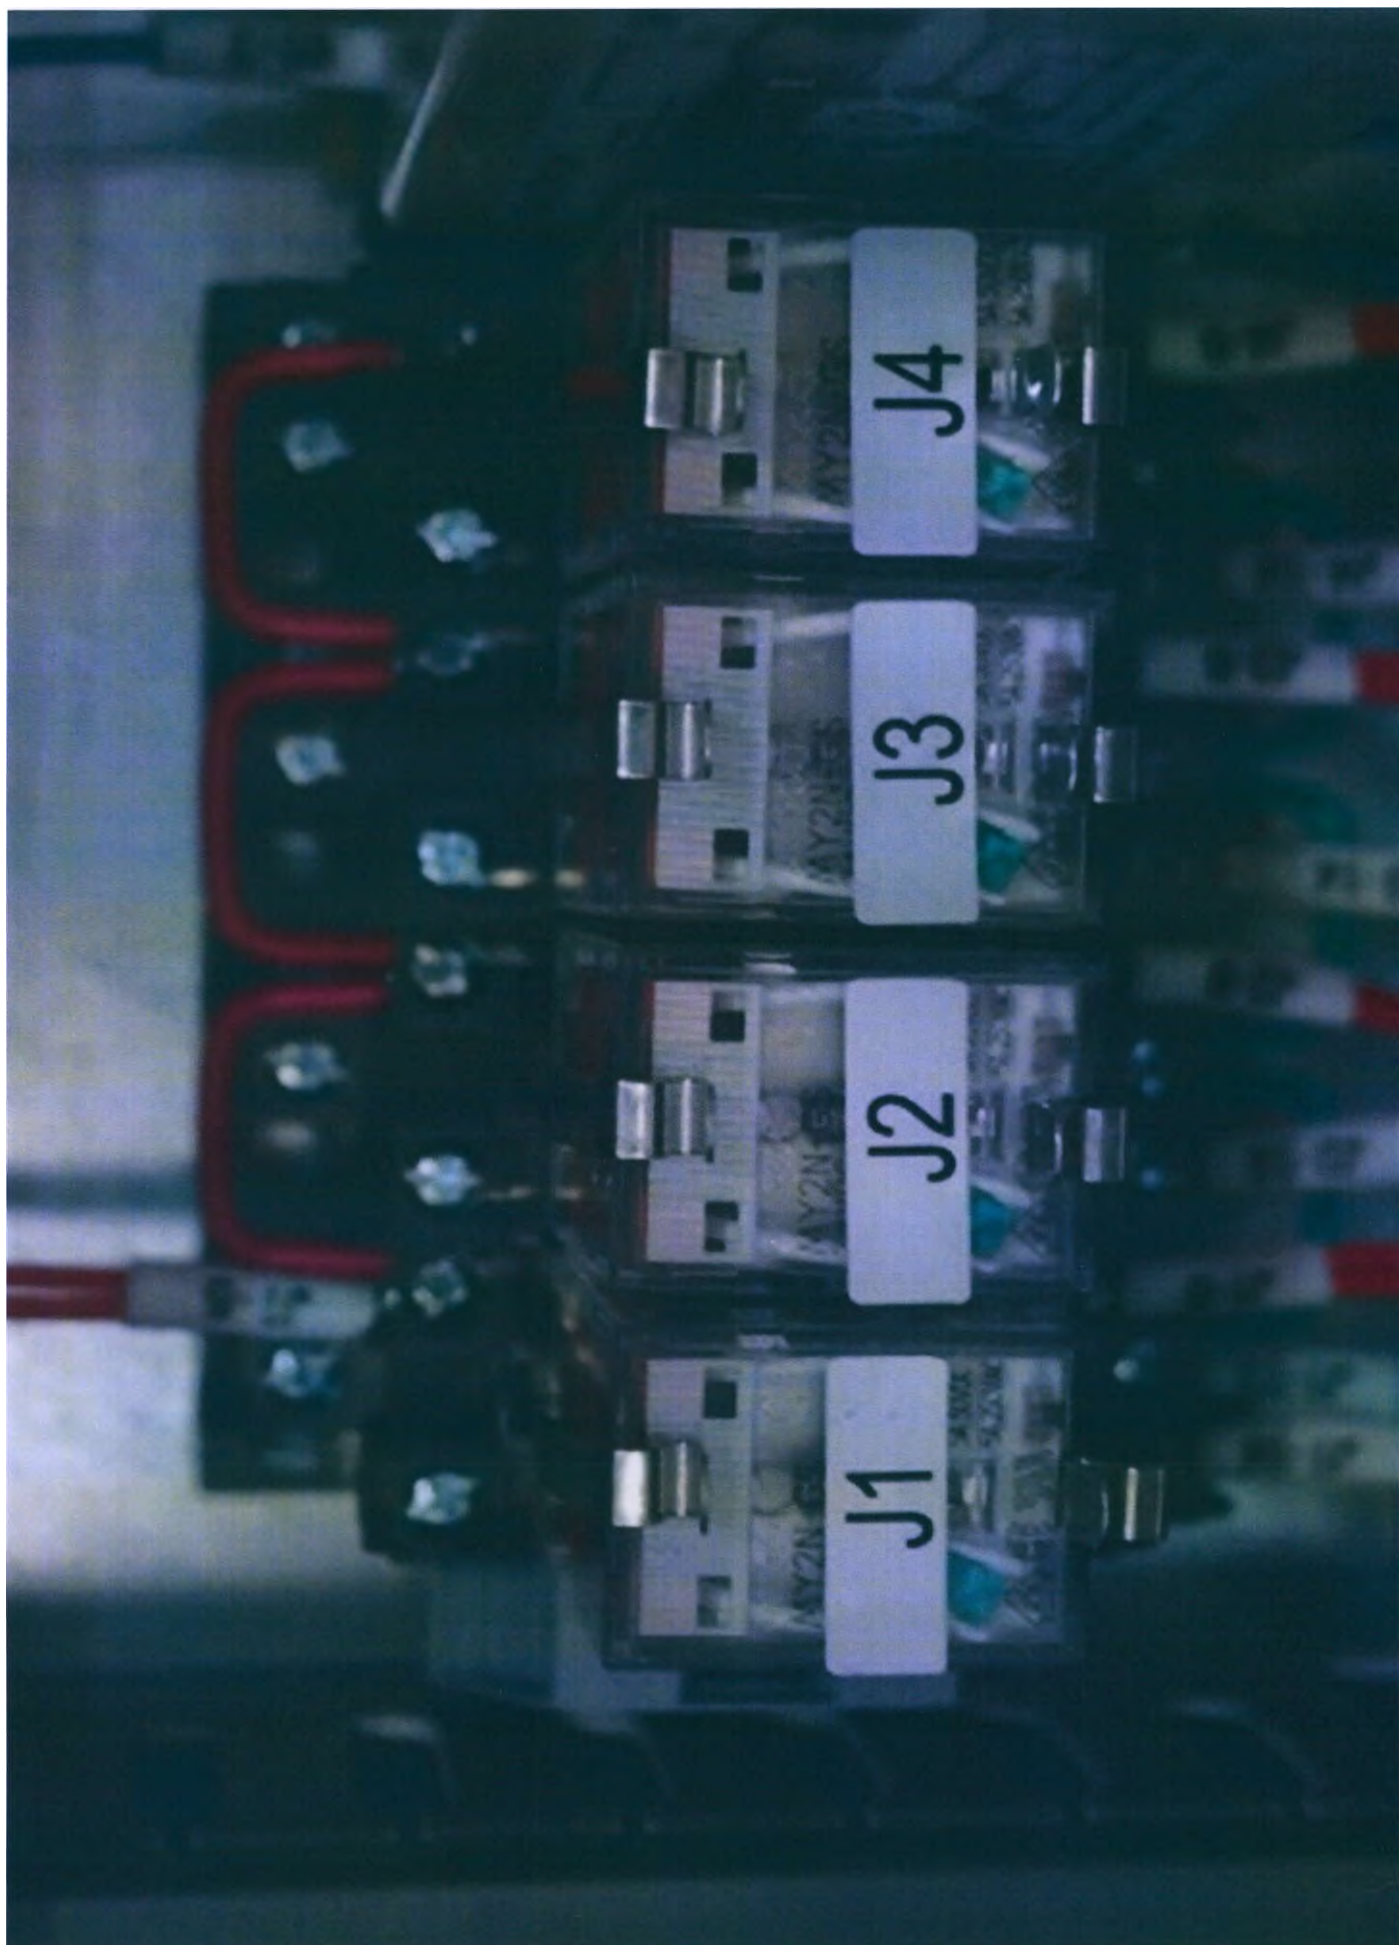

Реле электромагнитные

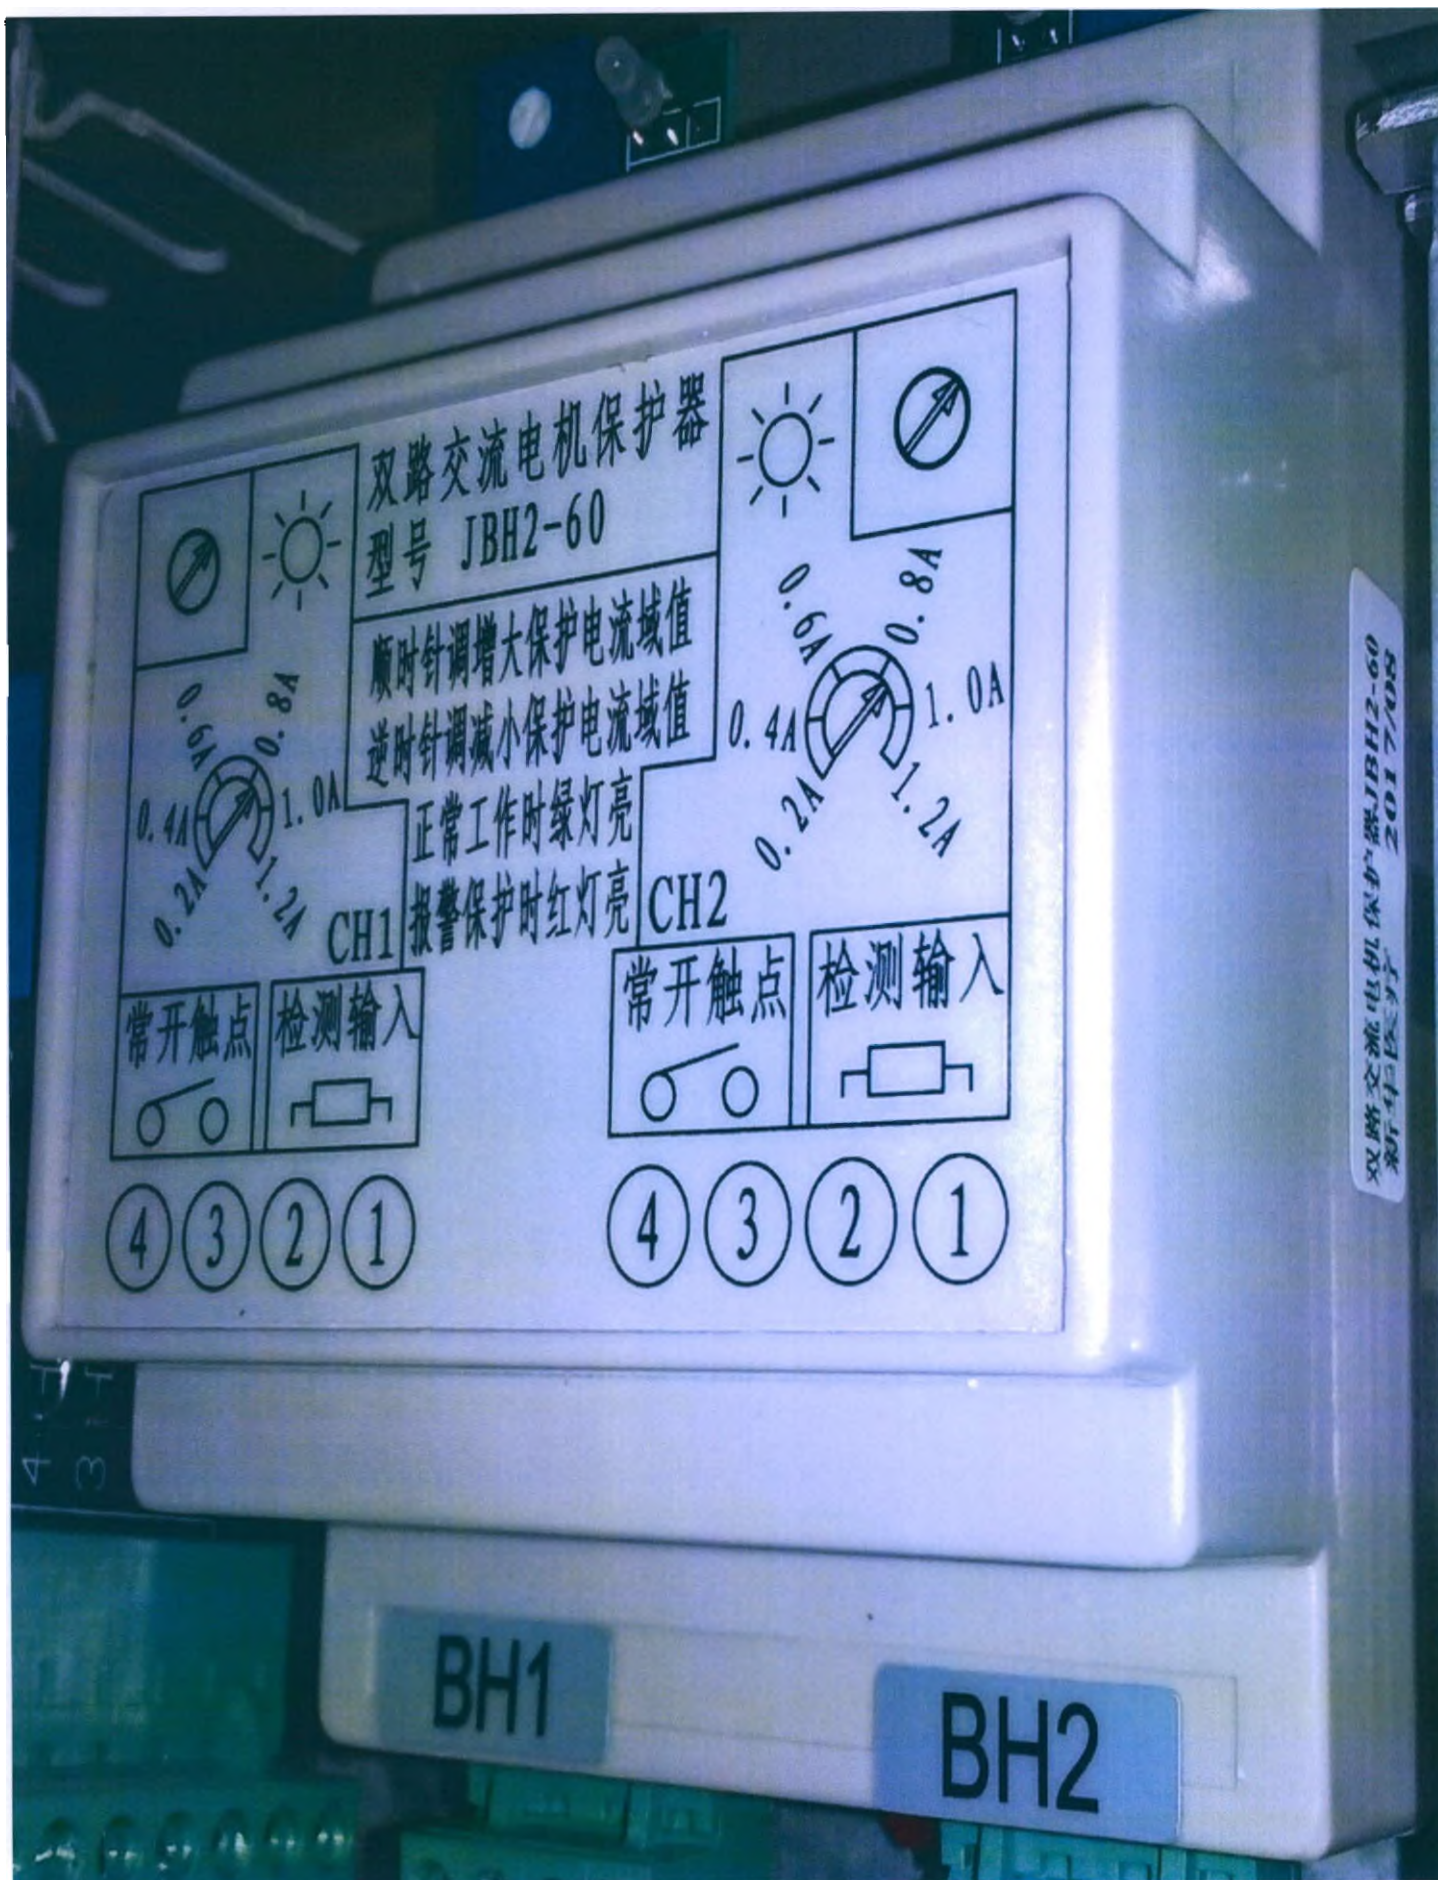

Релейная база

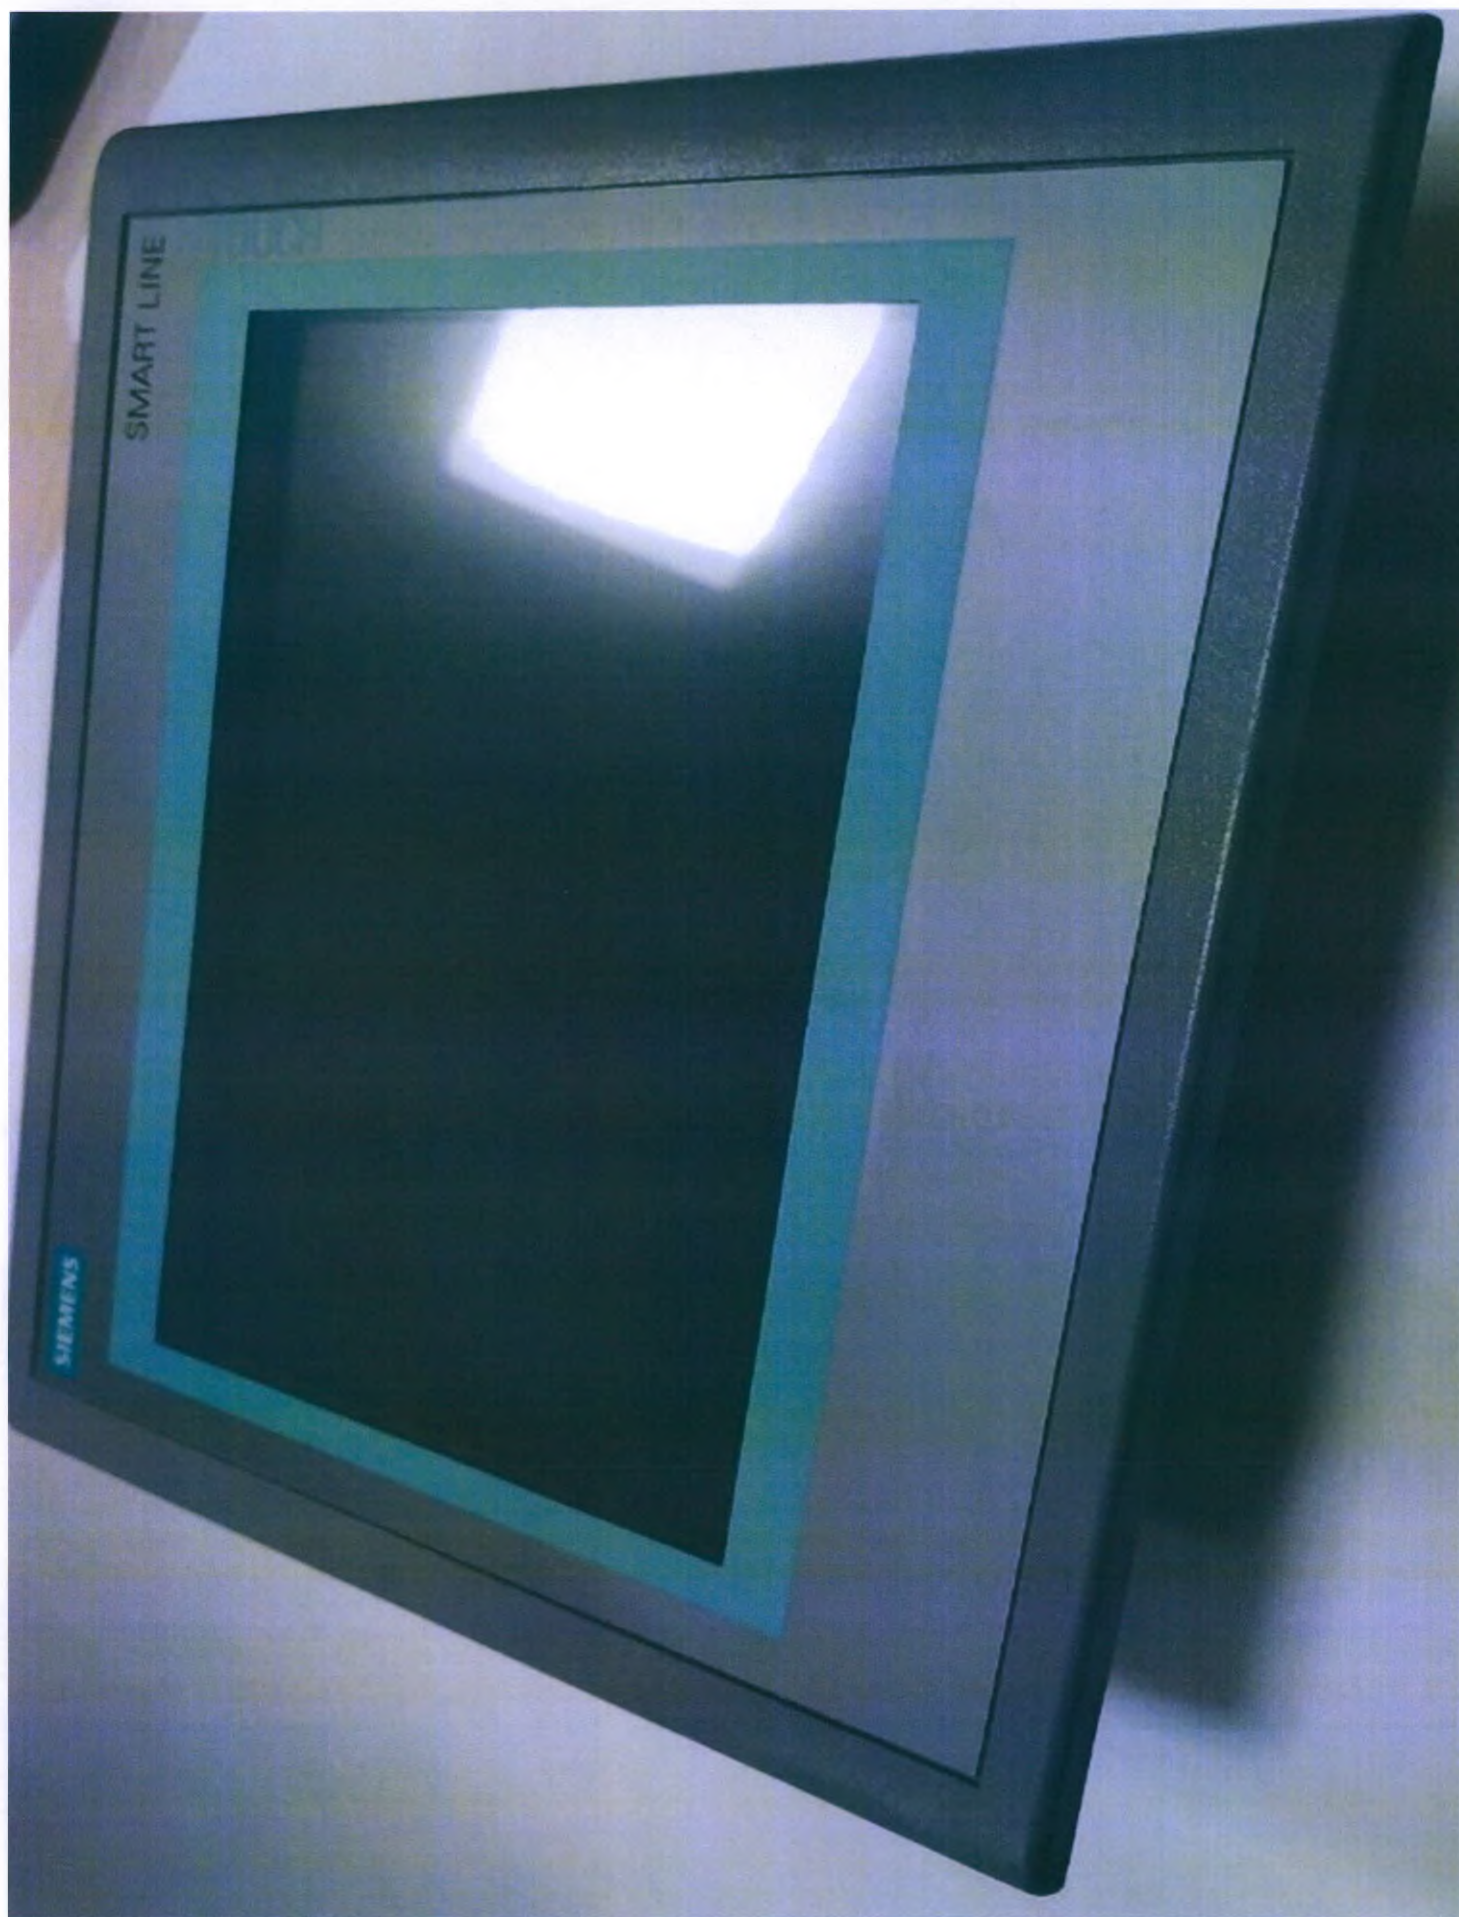

Сенсорный дисплей




Смазка для механизмов




Соединение быстросъемное типа "tri-clamp"



Тележка загрузочная

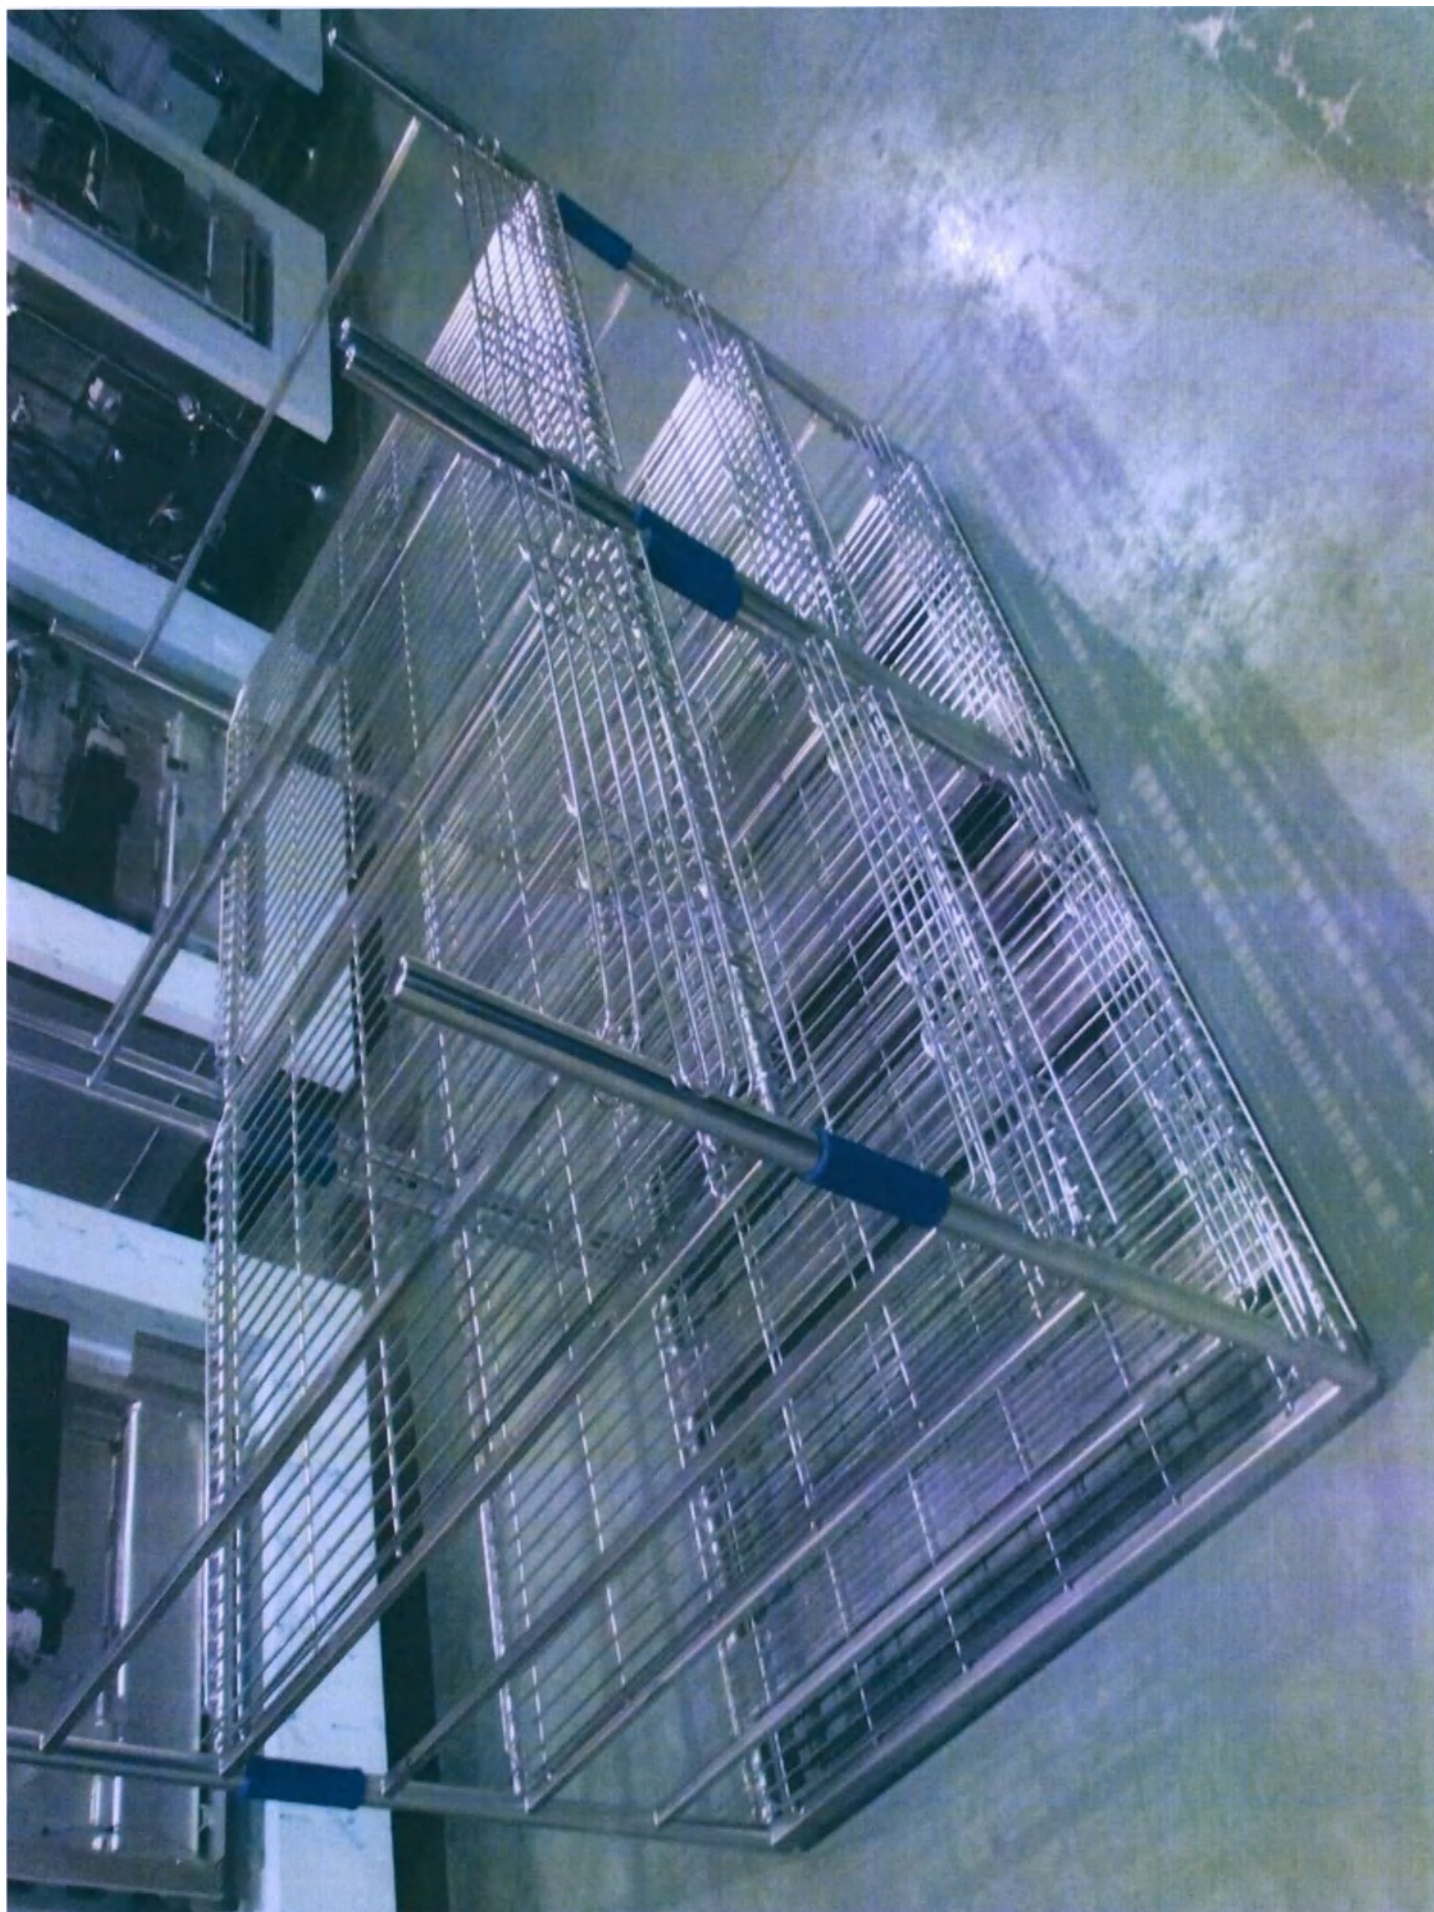


Тележка стерилизационная

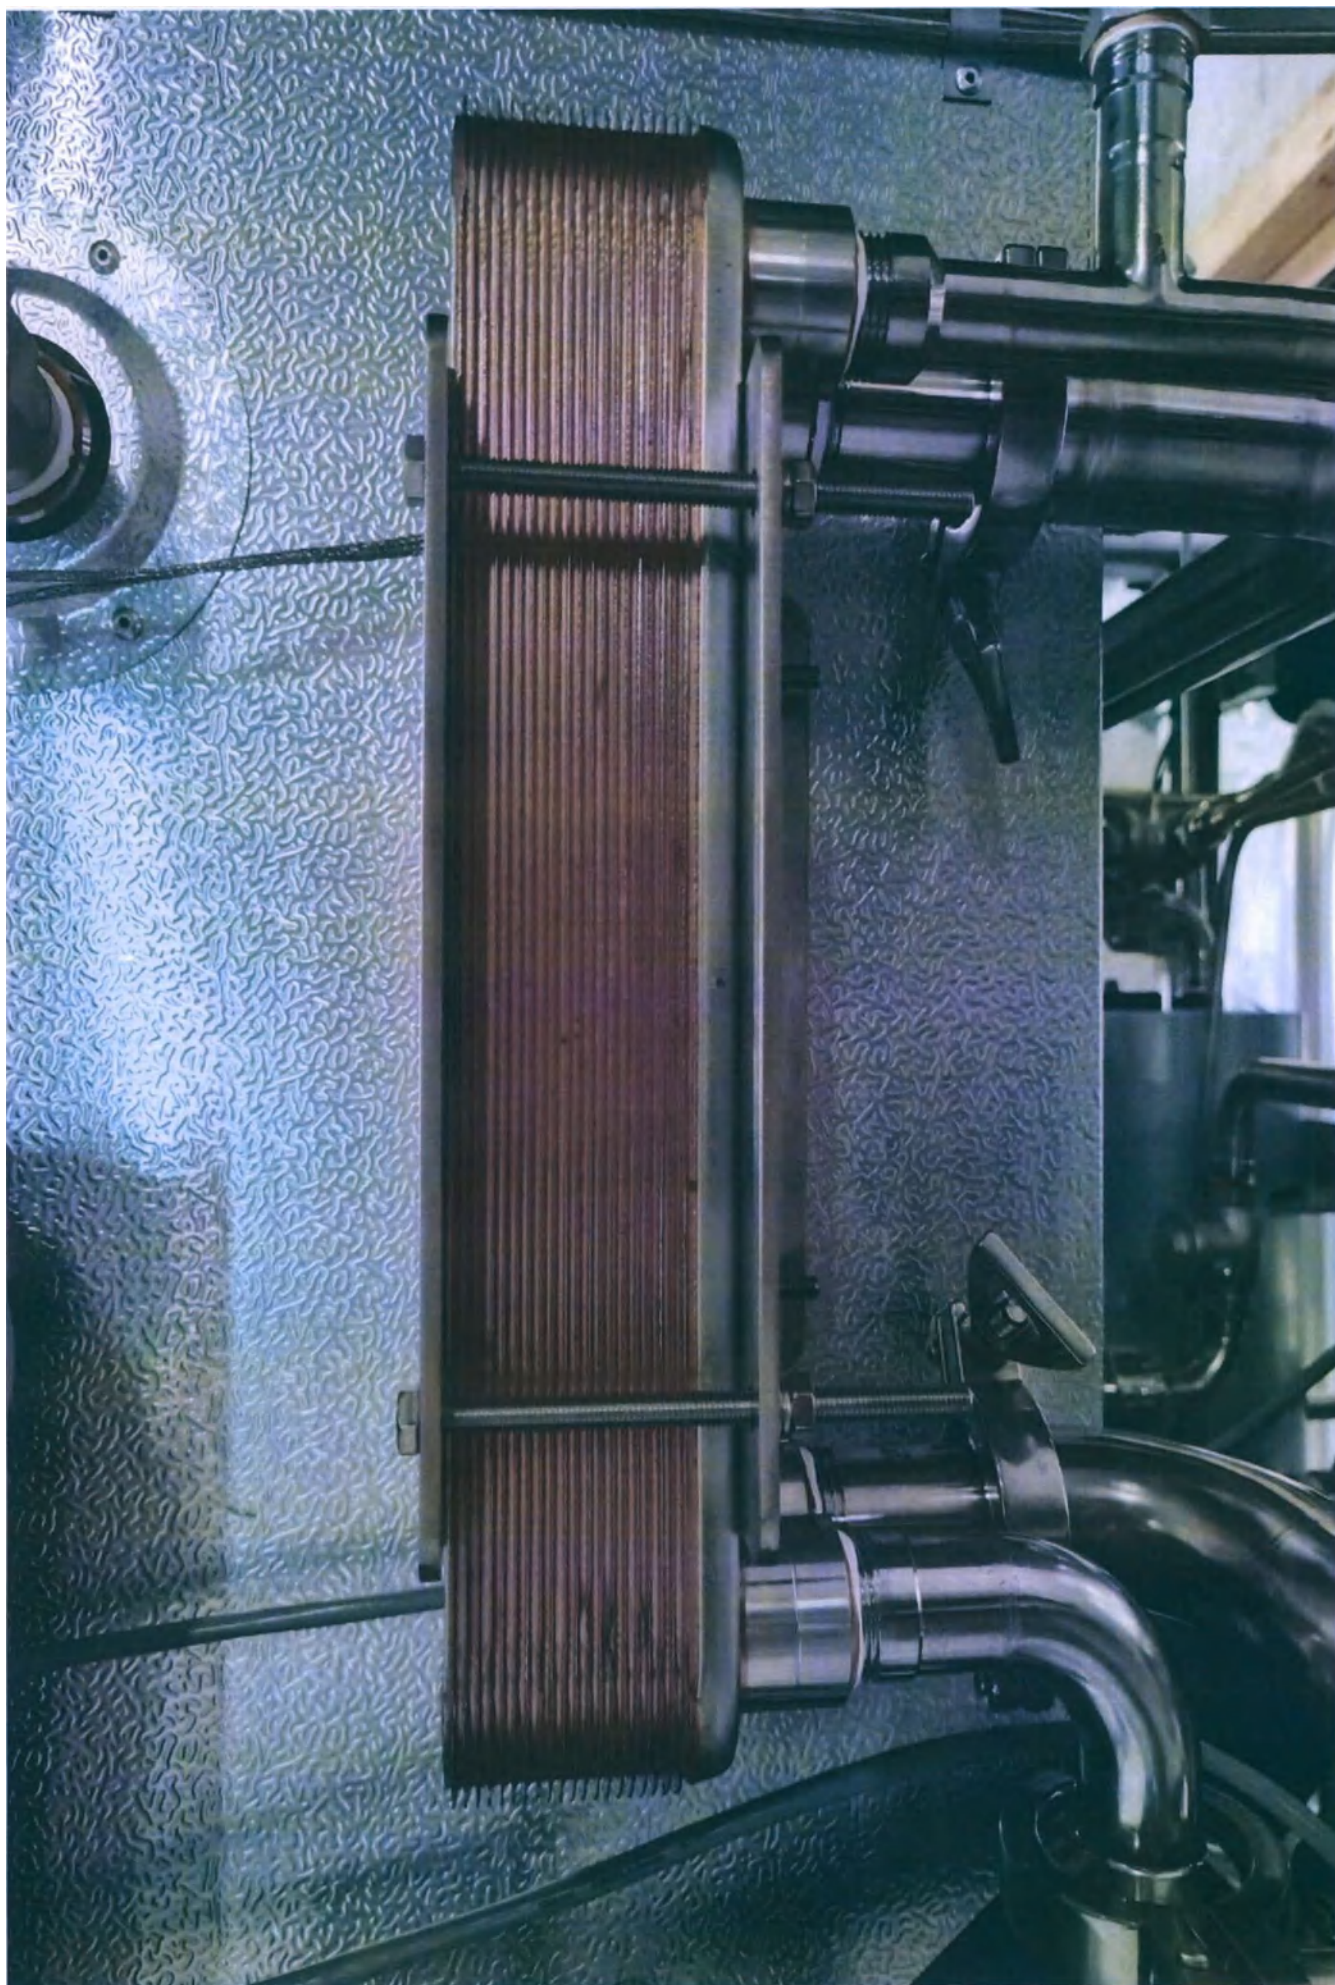


Теплообменник



Термореле

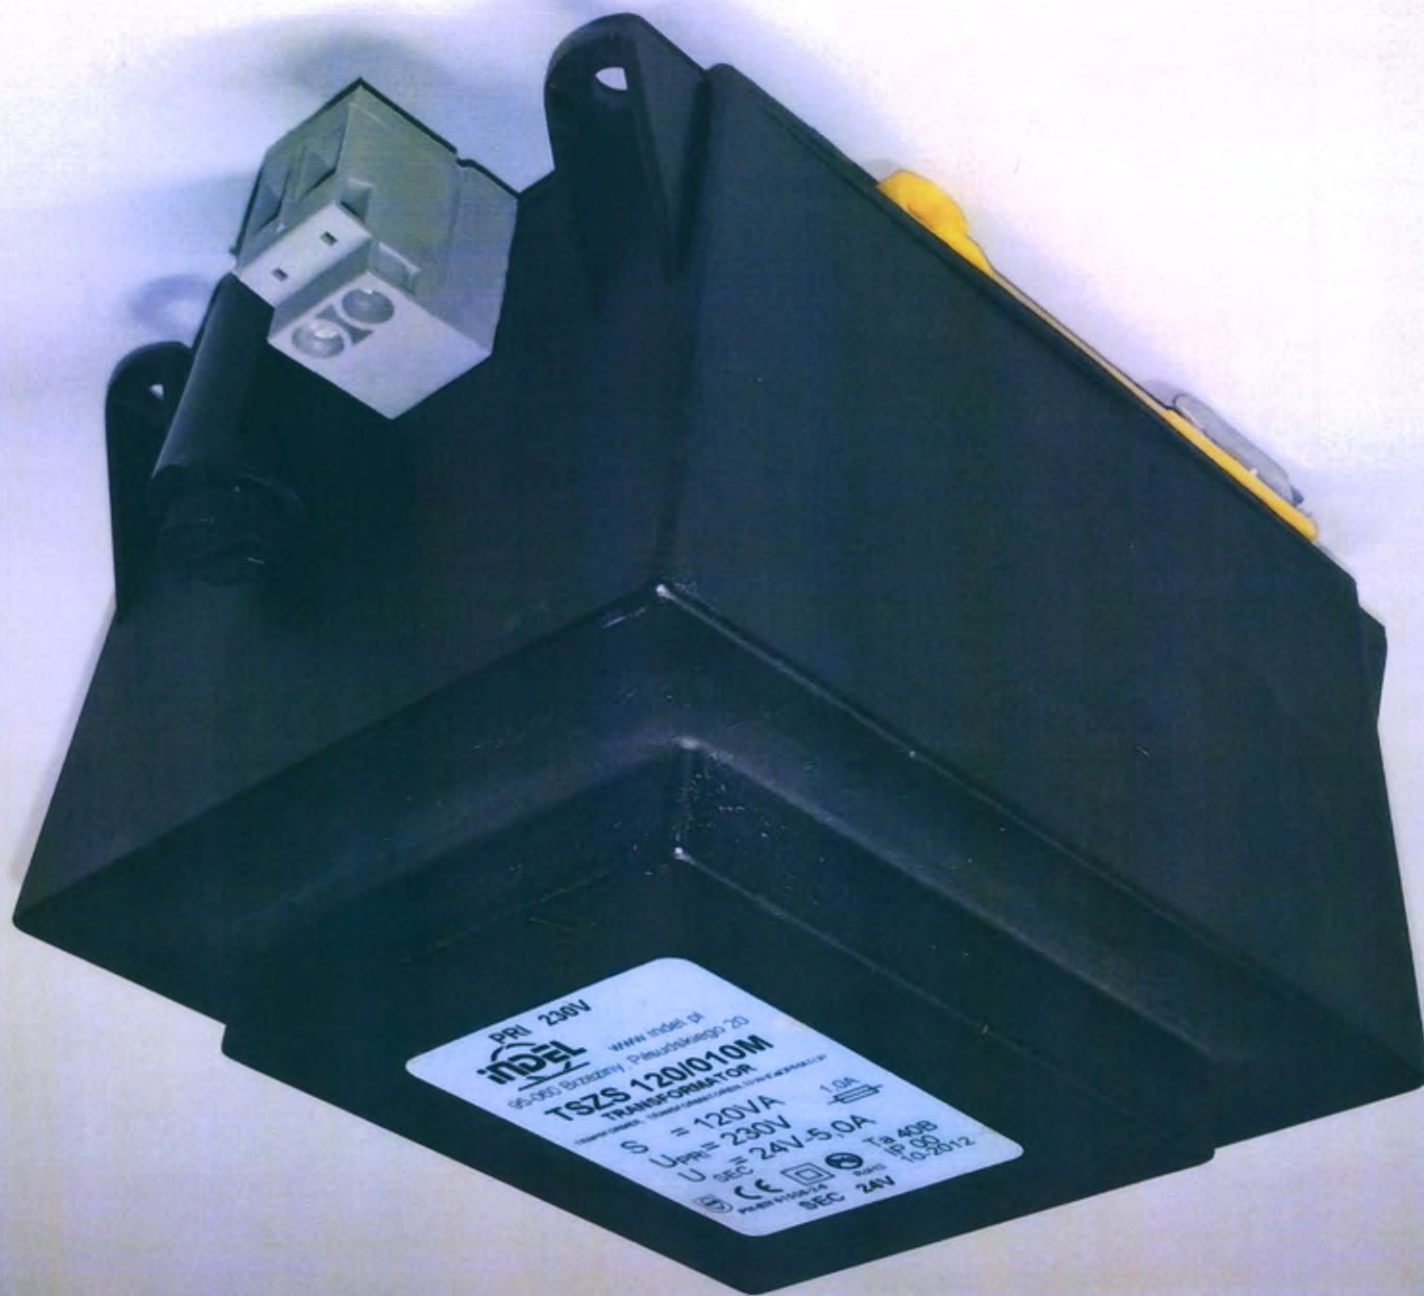

Трансформатор

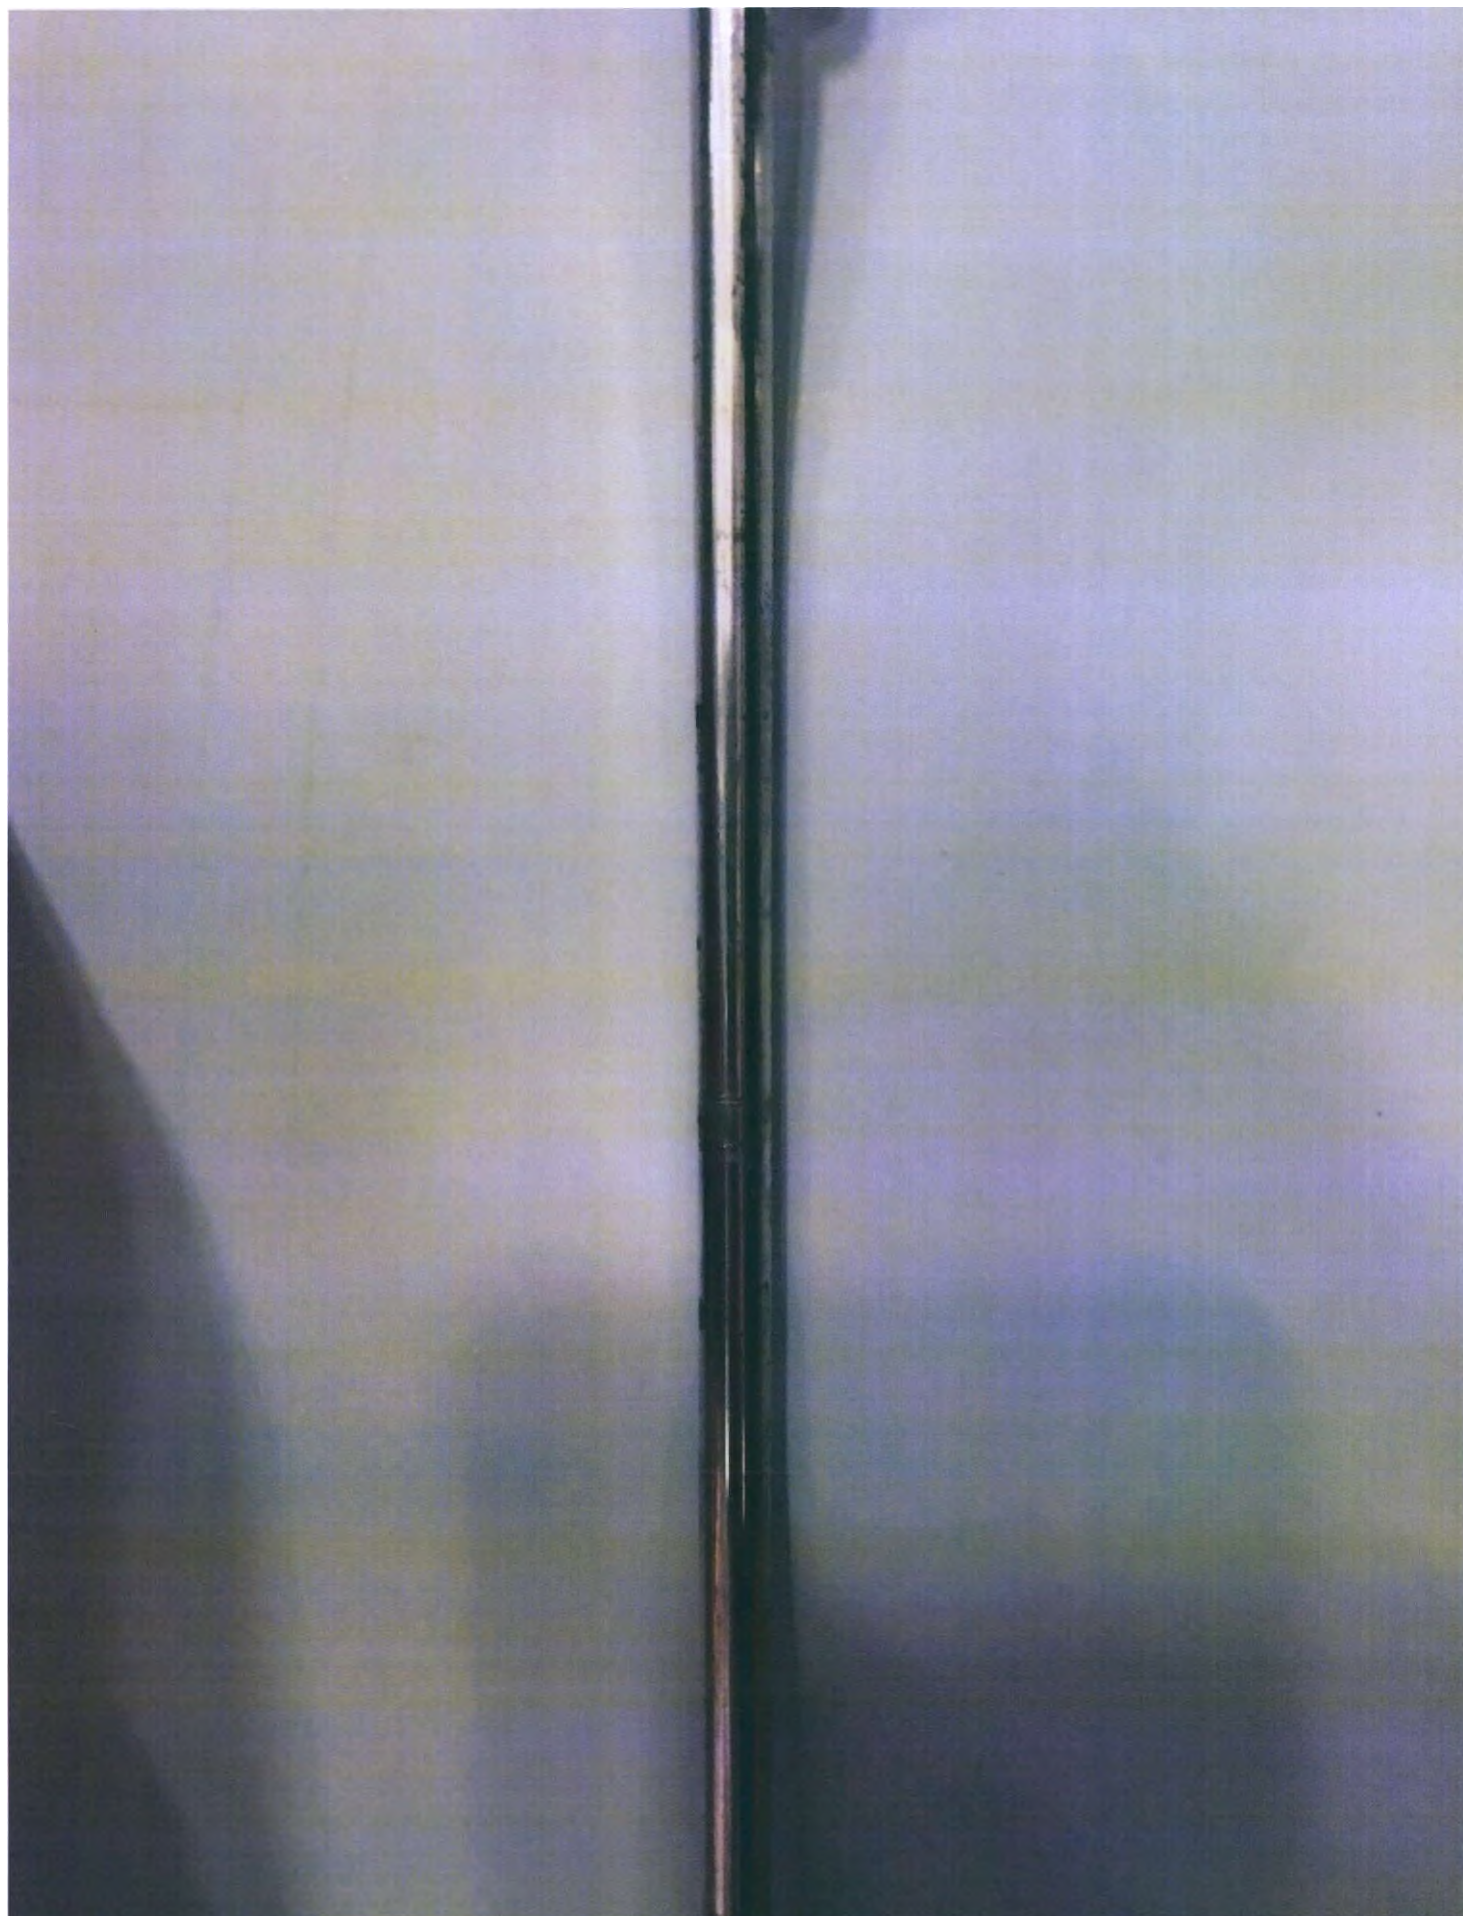

Трубка пневматическая




**Умягчитель воды автоматический (для исполнений DGM-100 – DGM-2000)
или**




**Умягчитель воды автоматический (для исполнений DGM-130 - DGM-360)
или**




Умягчитель воды автоматический (для исполнений DGM-360 – DGM-2000)

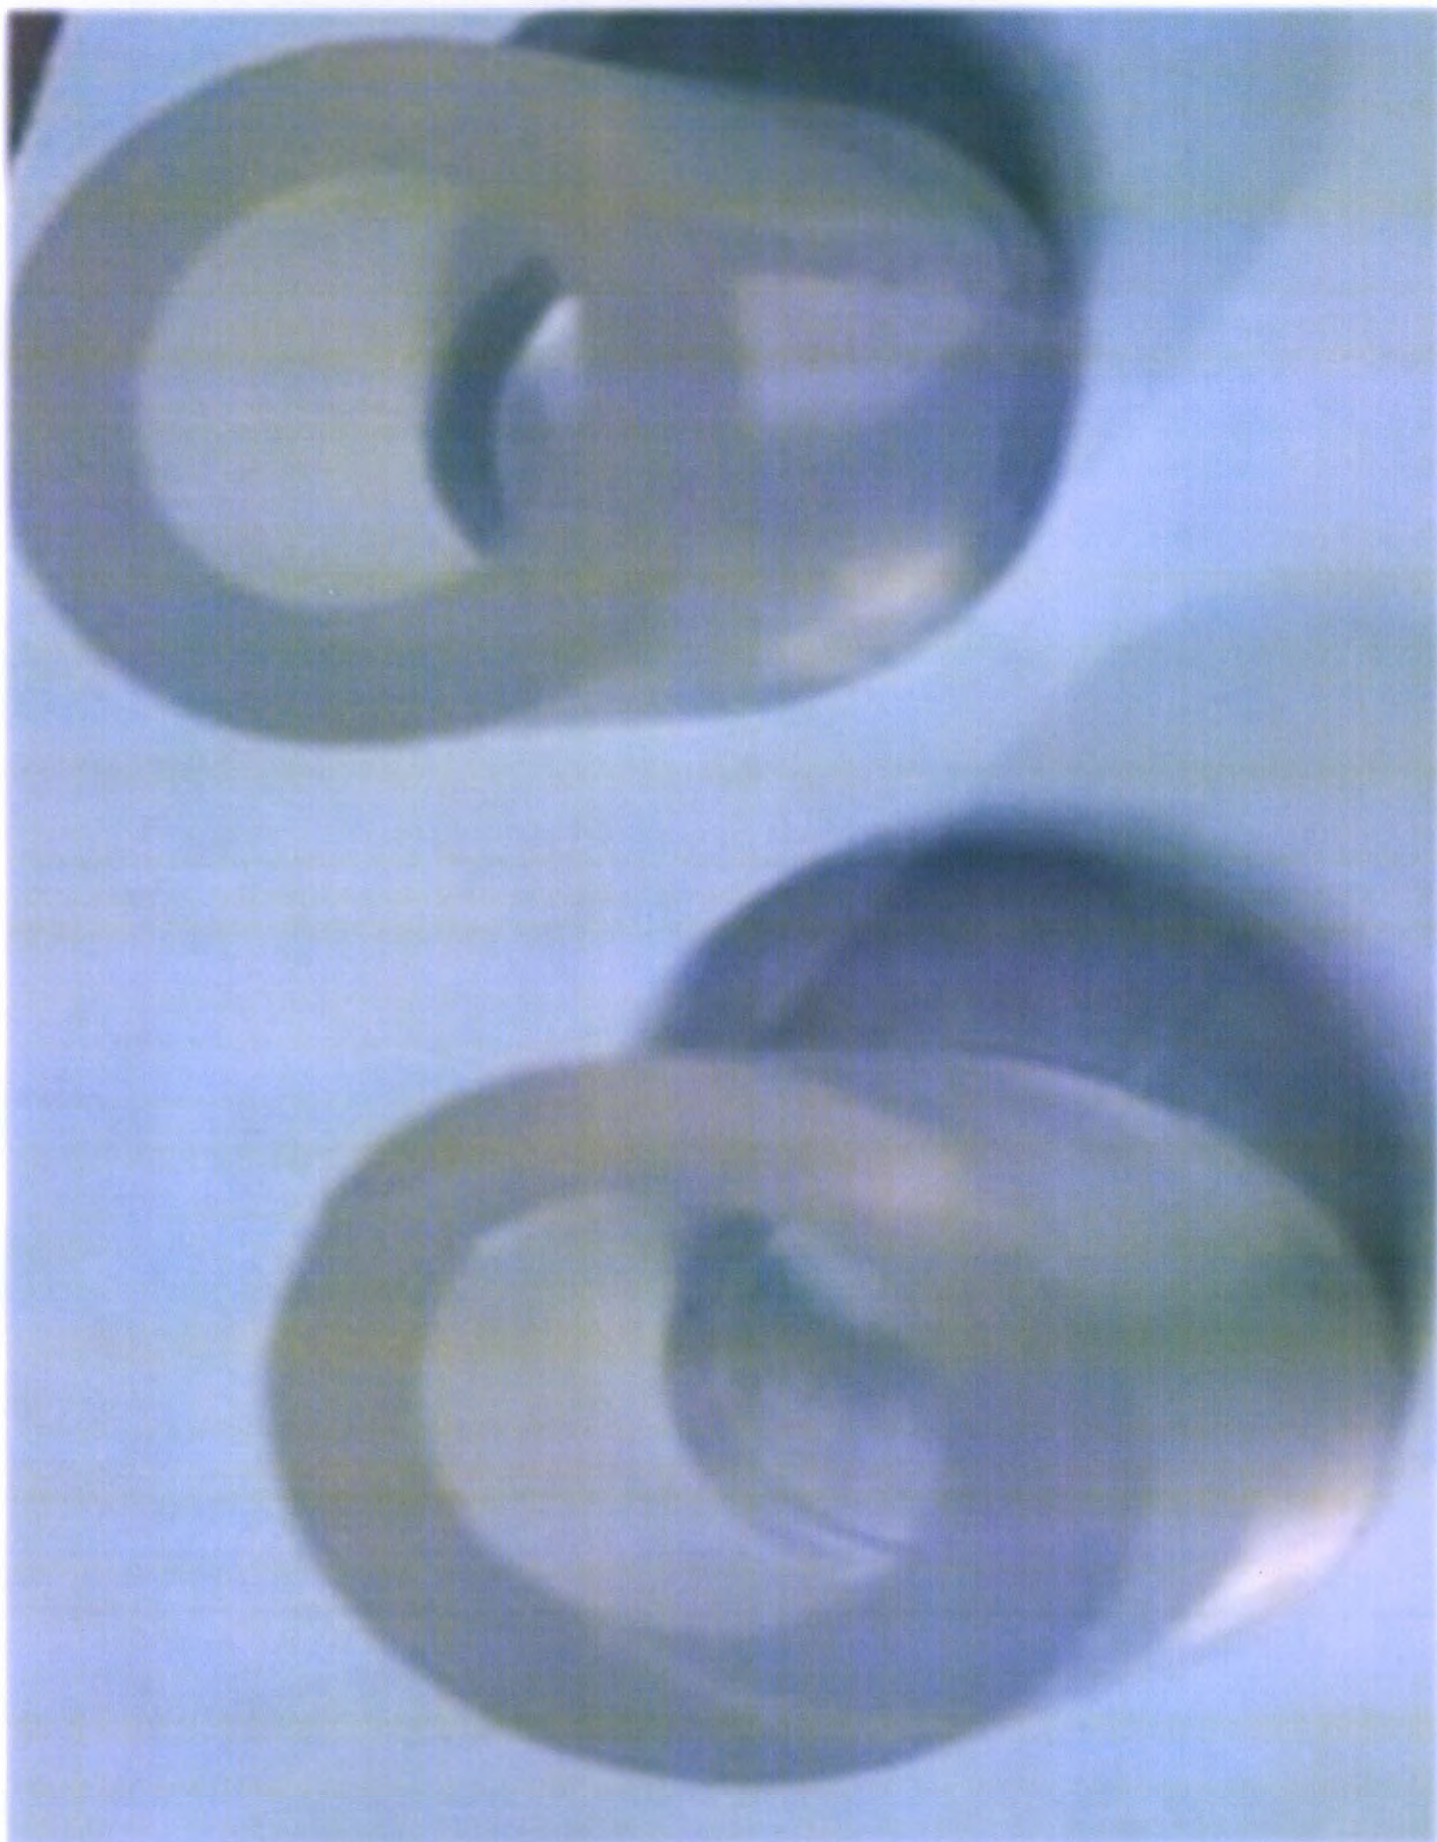

Уплотнитель водомерной колонки, водомерного стекла

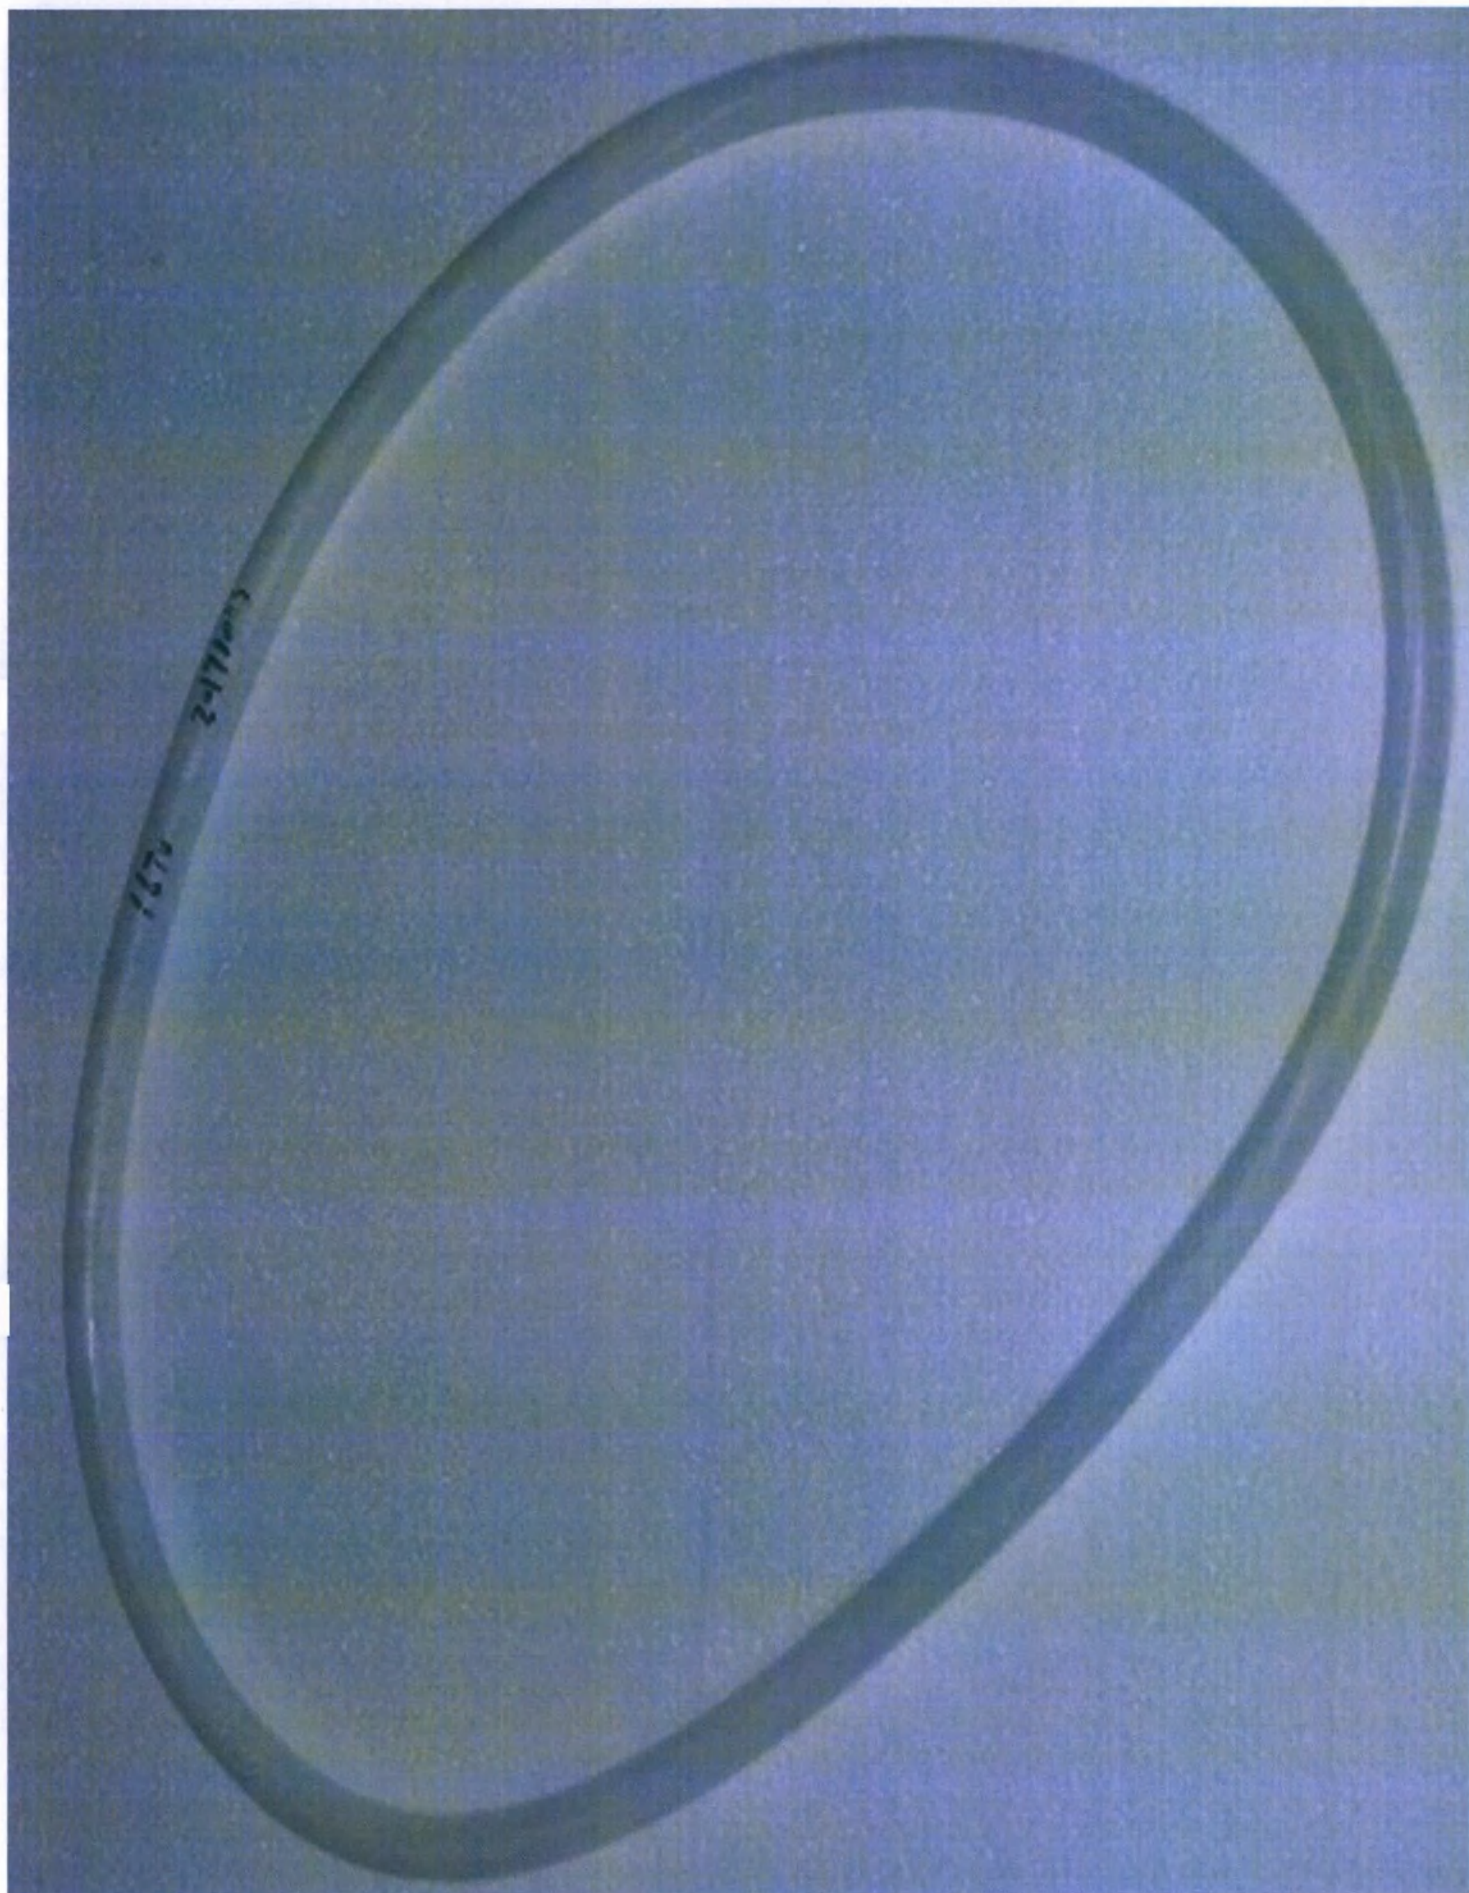

Уплотнитель дверей

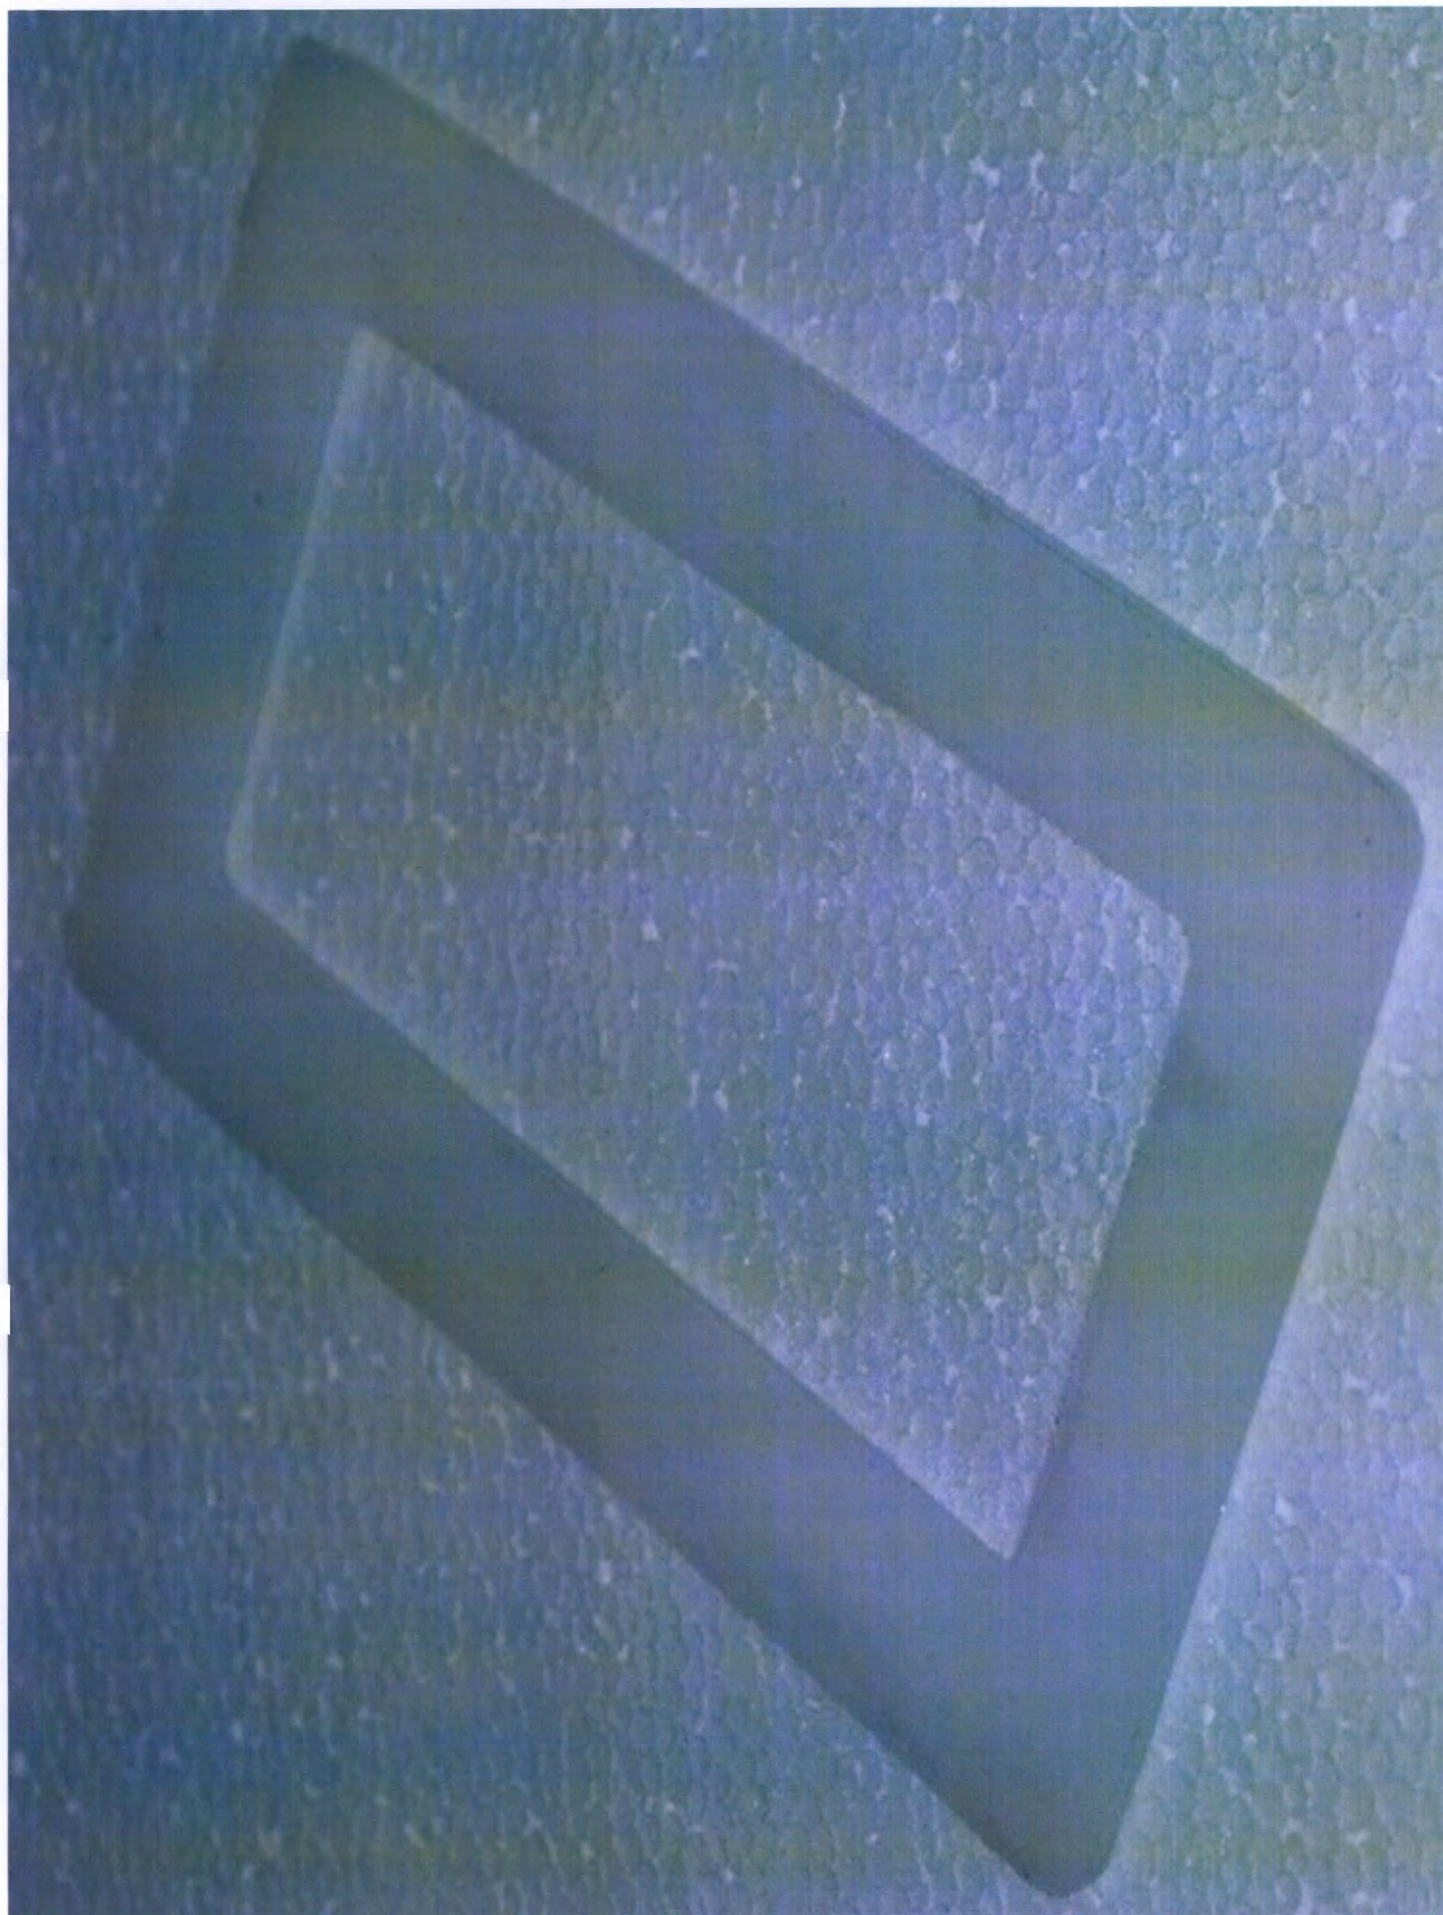

Уплотнитель люка парогенератора



Фильтр бактериологический



Фильтр воздушный



Фильтр глубокой очистки питающей воды



Хомут




Цепь





Электронагревательный элемент воздушный

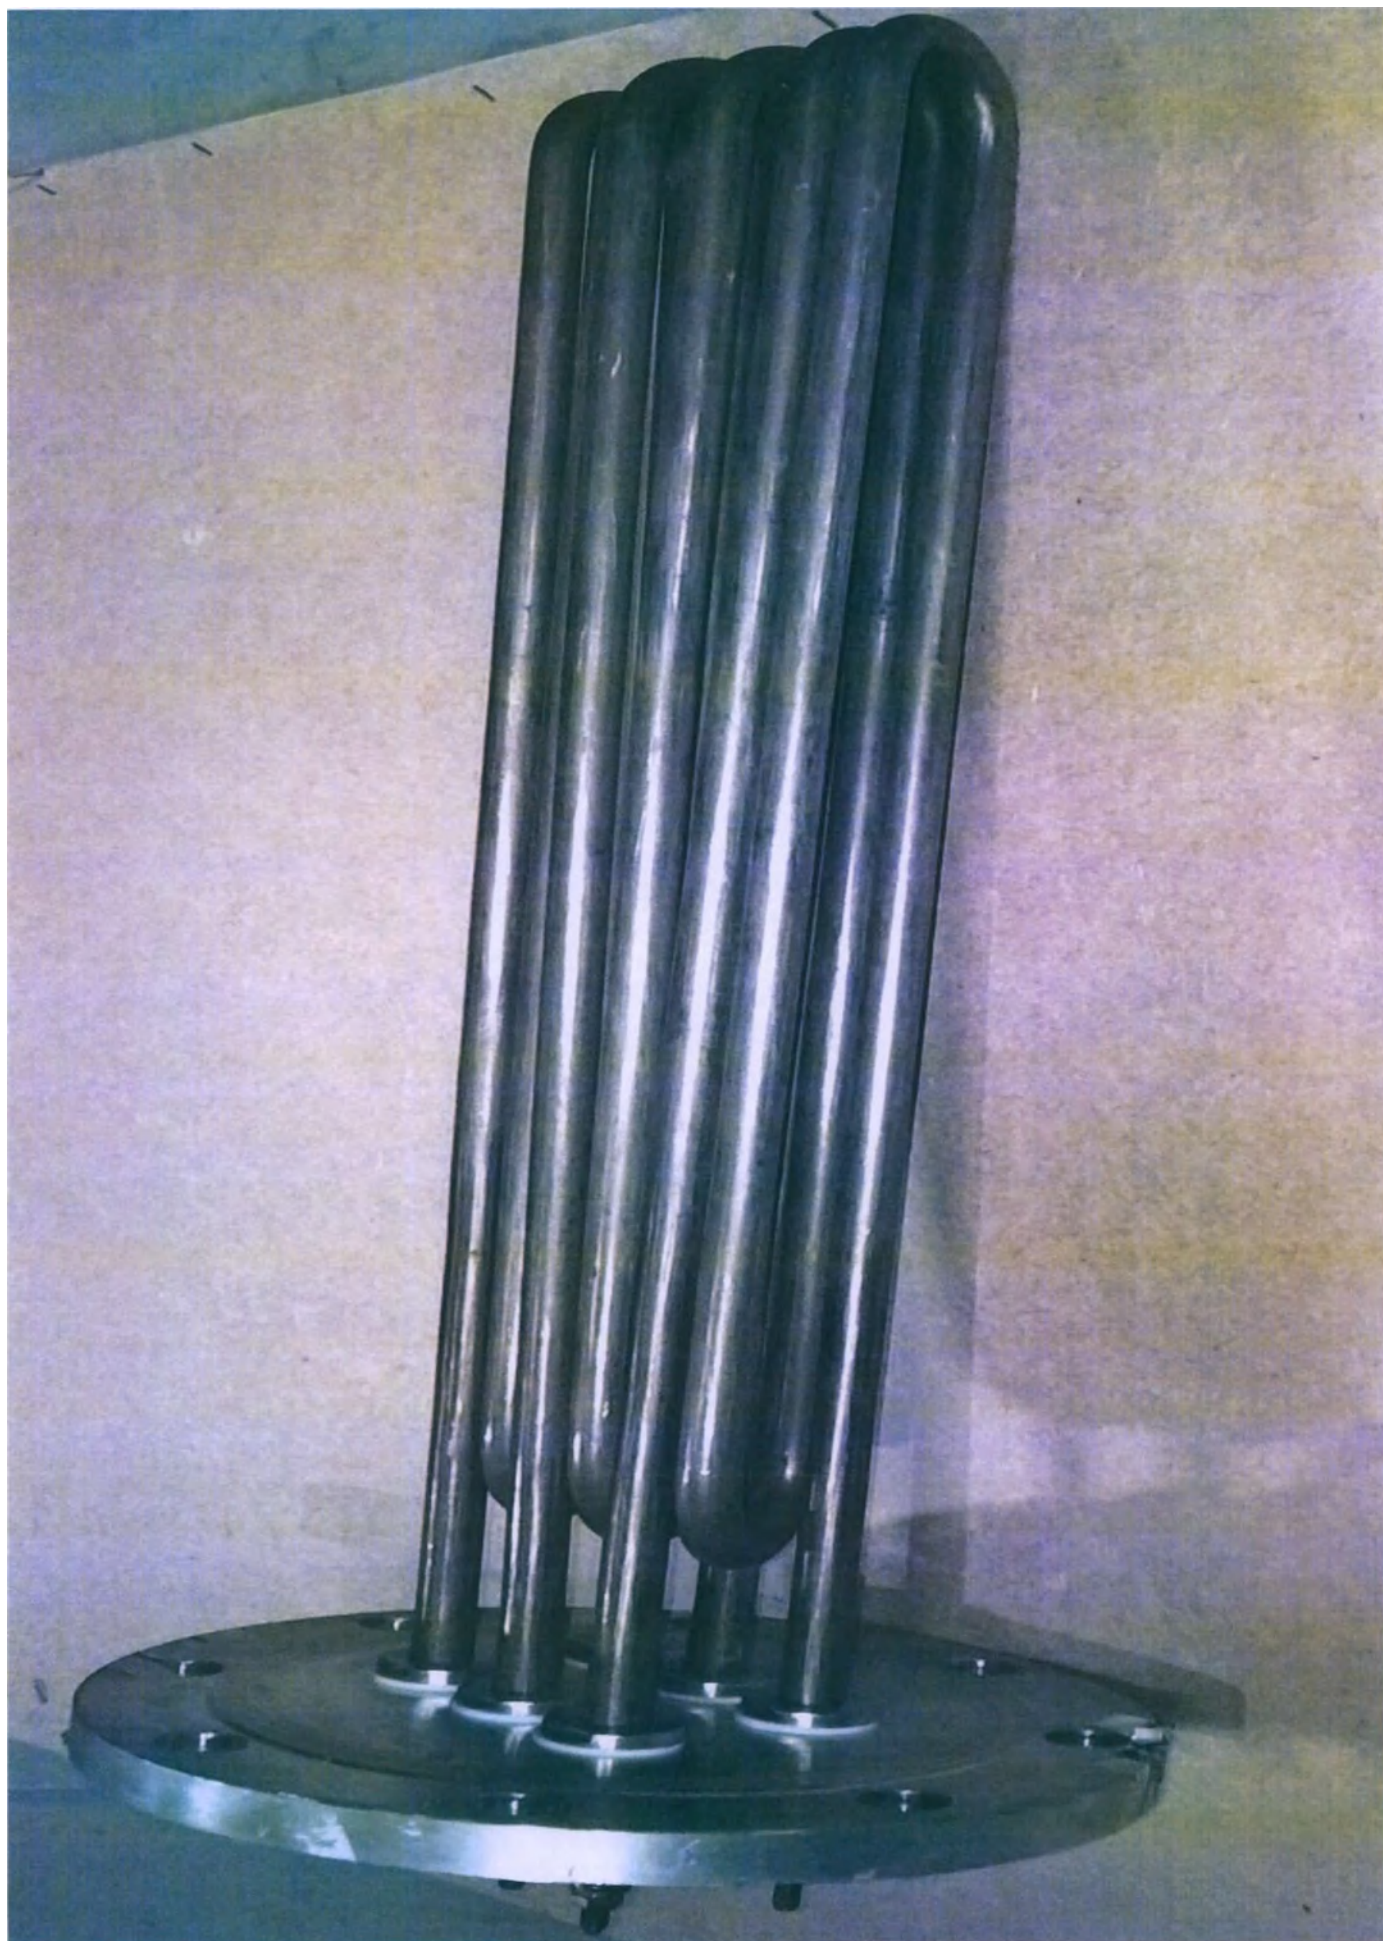

Электронагревательный элемент водяной



Электрод уровня воды

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

126 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ДМ ФАРМА-АППАРАТЕ
РУС»

Иващенко А.А.

