




**Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 и определения делеции DEL31-33 в гене N, характерной для варианта В. 1.1.529 Omicron, методом ОТ-ПЦР-РВ
«CoV-2-тест-dif-O», партия 202208-281
Форма комплектации 1**

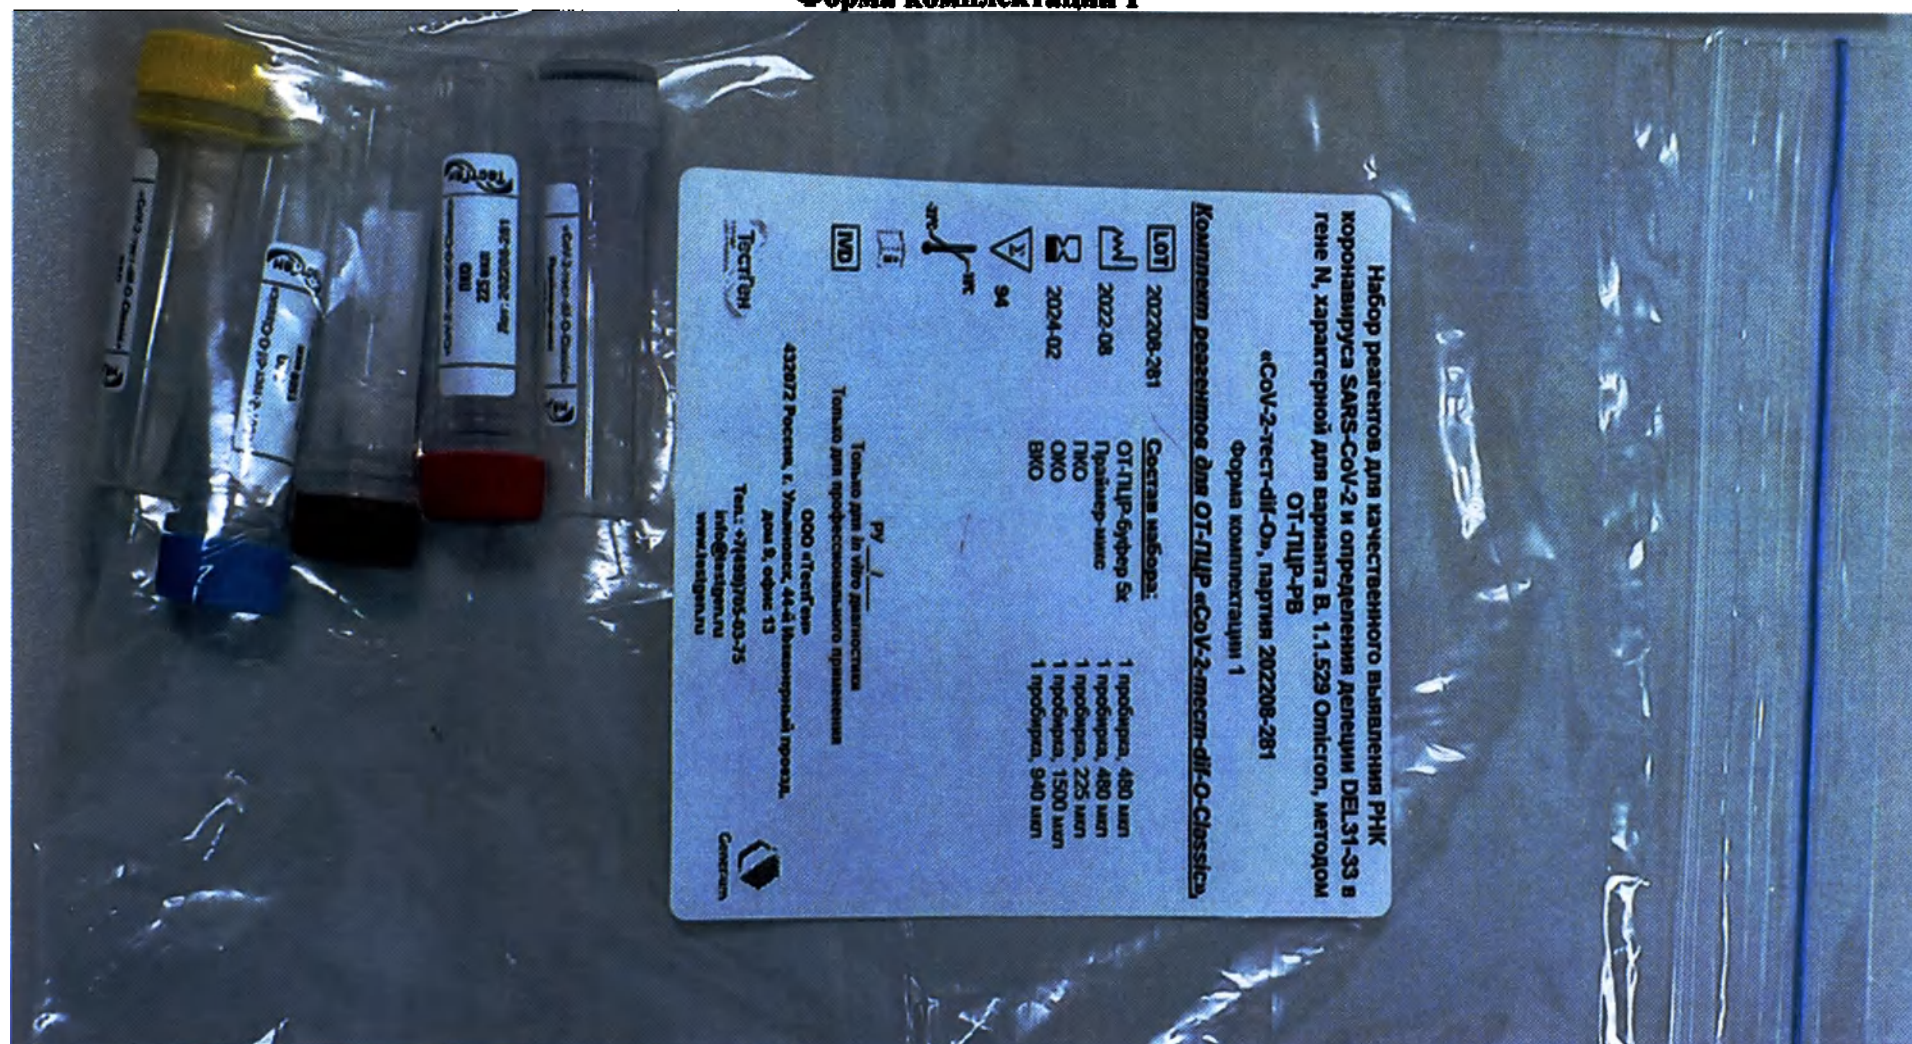

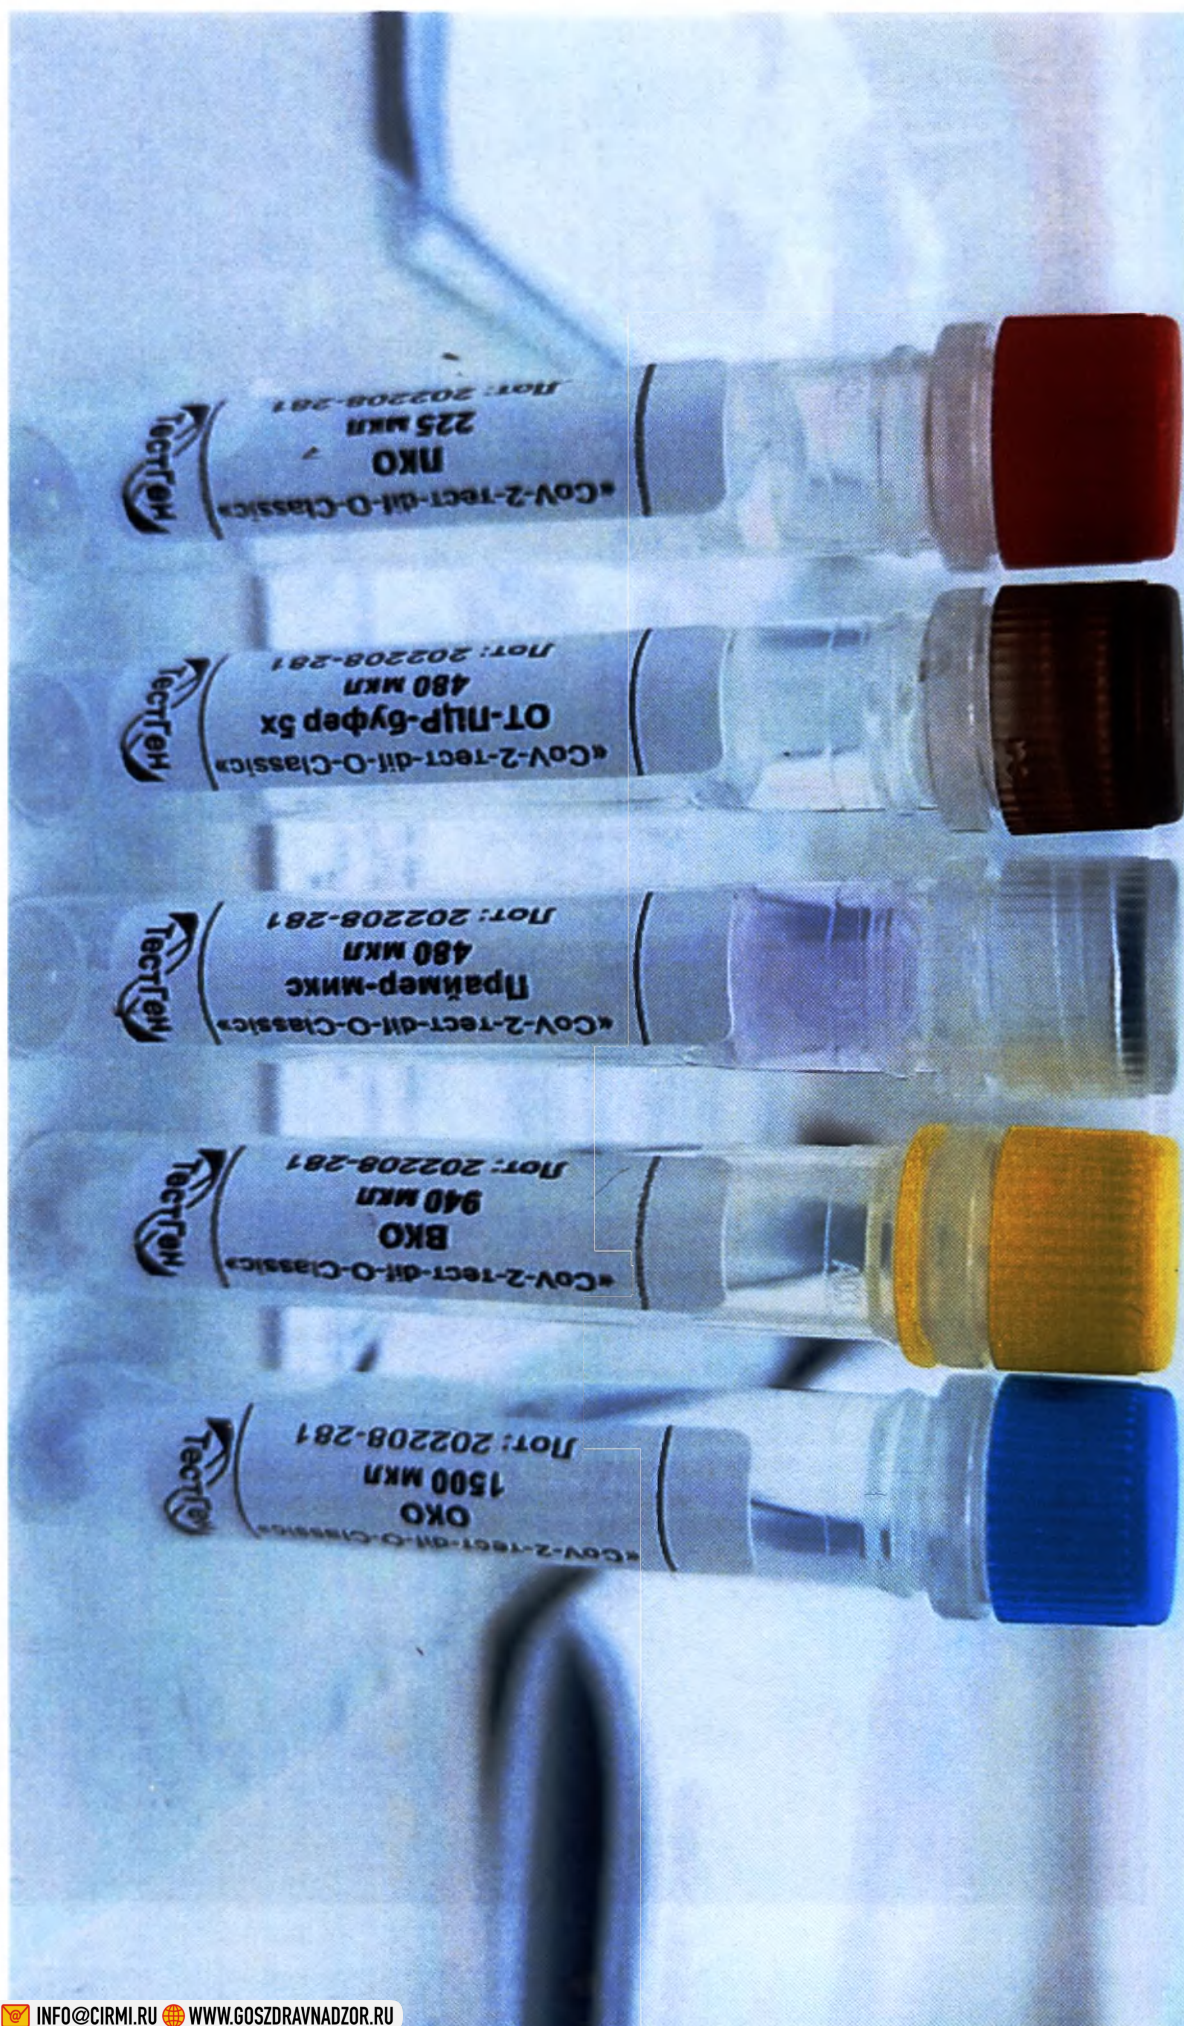

Форма комплектации 2

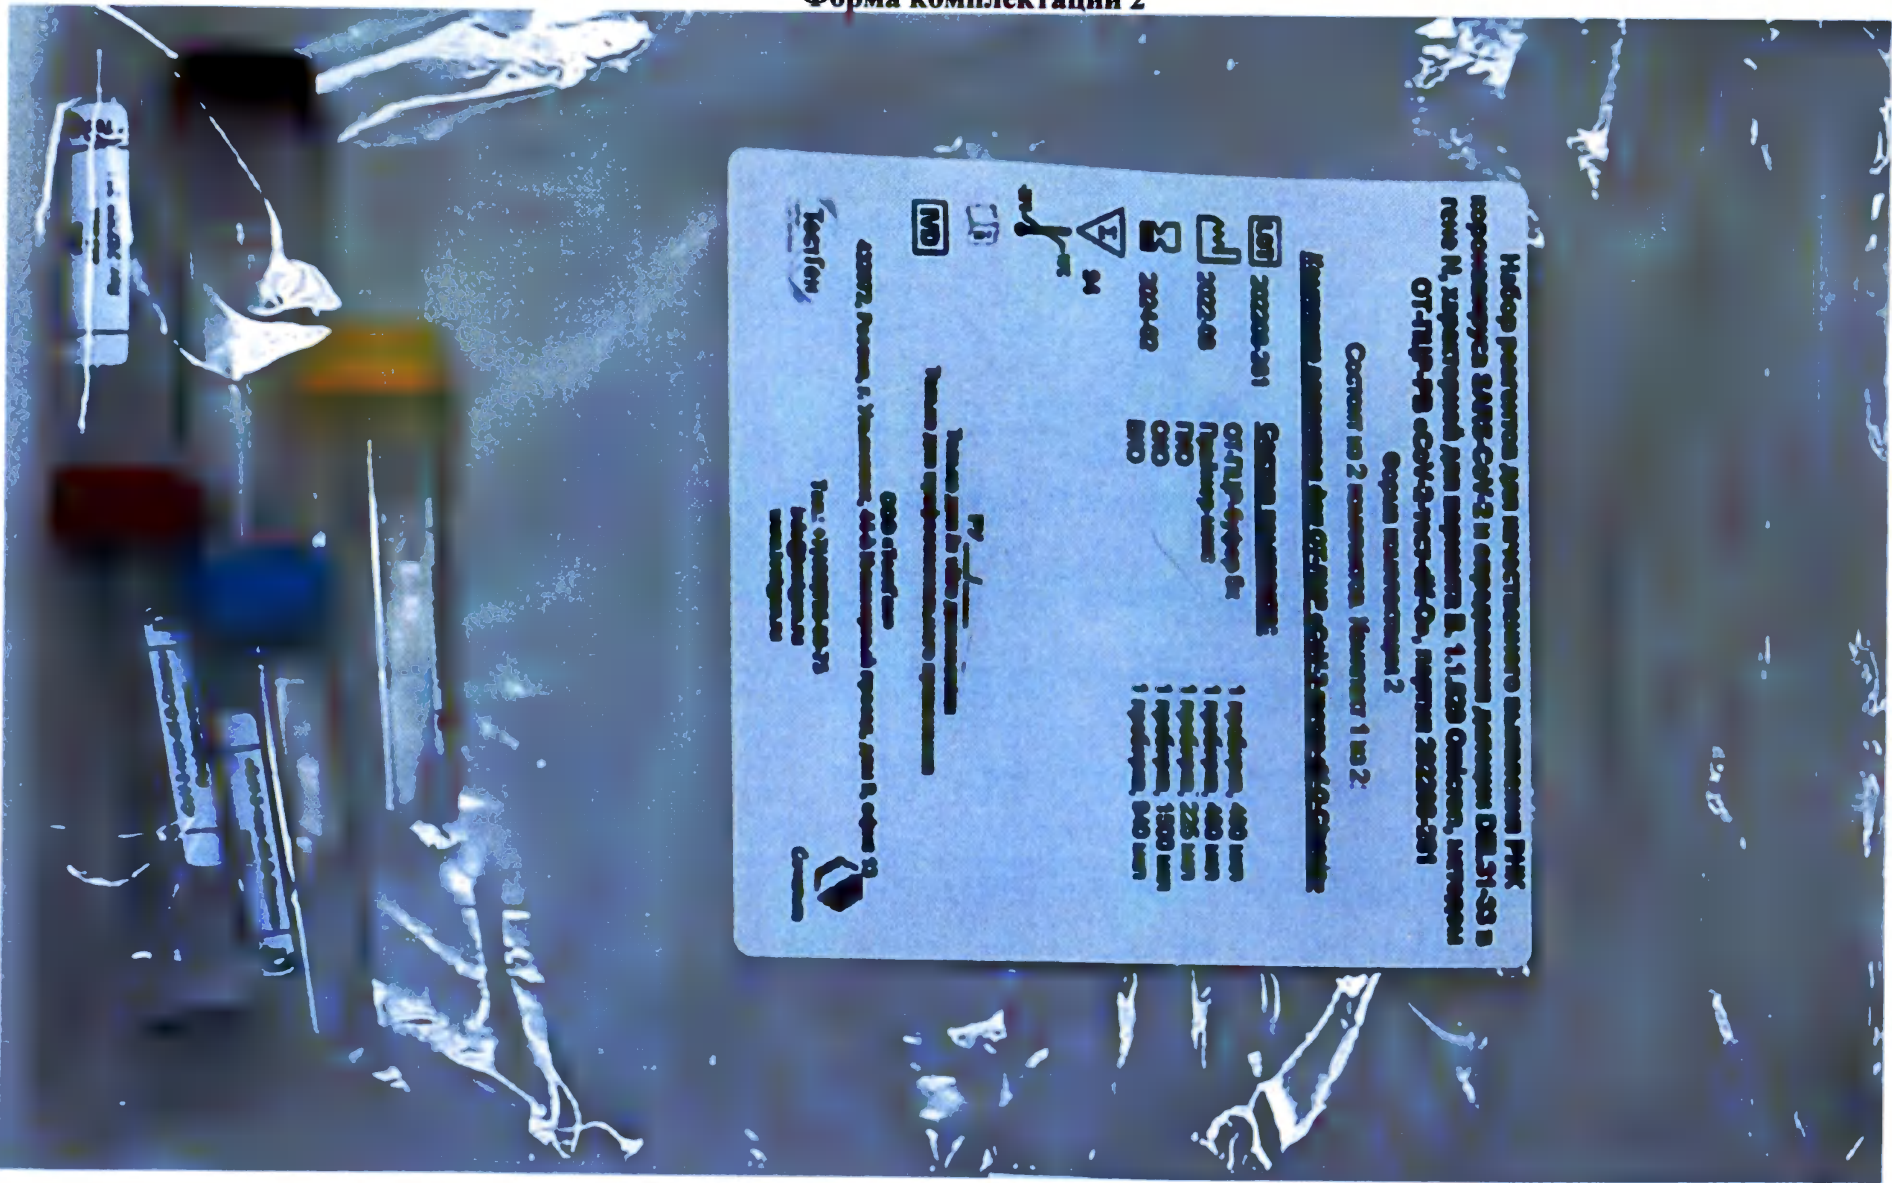


Набор рентгена для исследования вывихов ПНК
 порометруса SART-CoV-2 и сопоставления ленточки DEL-51-53 в
 ленте N, излучатель для аппарата B, 1,1,629 Омлетон, излучатель
 OT-711P-718 eCoV-2-1003-41-0, серия 202208-201

форма комплектации 2

Состоит из 2 комплектов. Комплект 1 из 2:

Изображение	Наименование	Количество
	OT-711P-640P Bx	1 комплект, 400 мм
	Портативный	1 комплект, 400 мм
	PNB	1 комплект, 225 мм
	ONO	1 комплект, 1500 мм
	WNO	1 комплект, 840 мм








Набор для исследования вывихов
 ленточек для рентгеновского аппарата

ООО «Цирми»

420072, Россия, г. Уфа, ул. Мухоморова, 44А Контактный центр, г. Уфа, ул. Мухоморова, 44А

Тел: 0342-970-40-75
 e-mail: info@cirmi.ru
 www.cirmi.ru



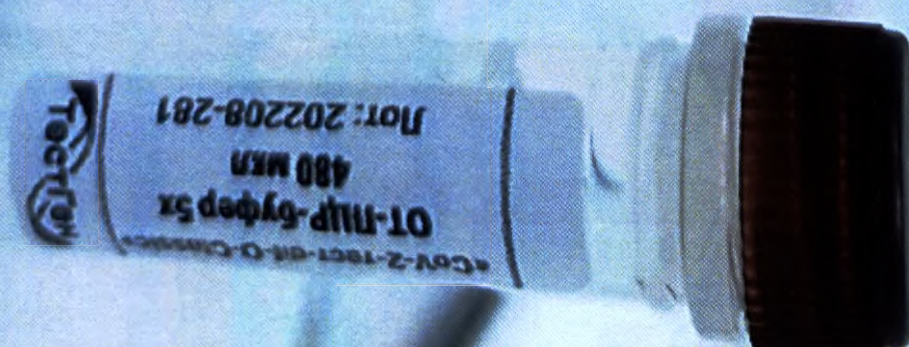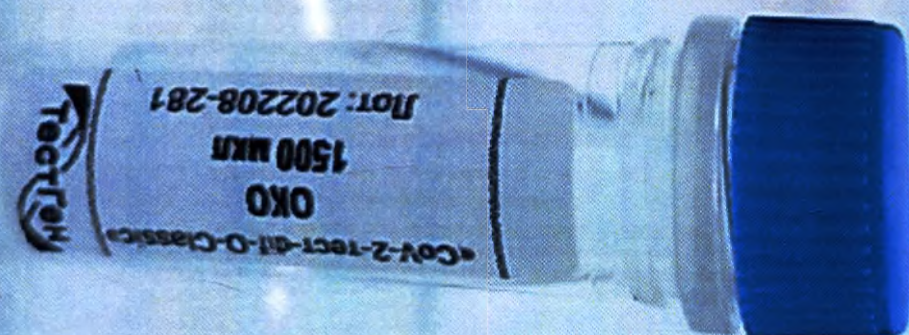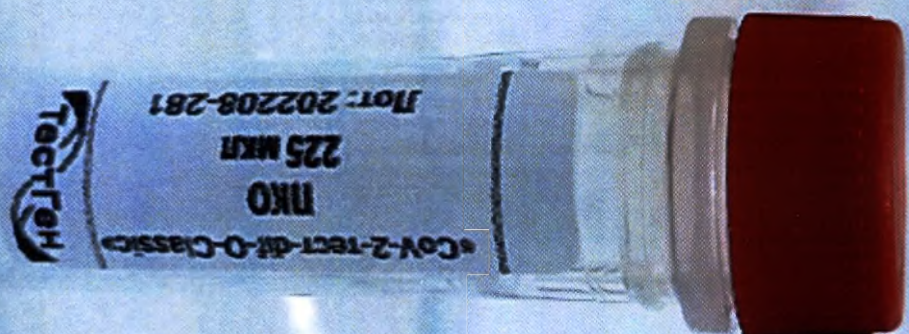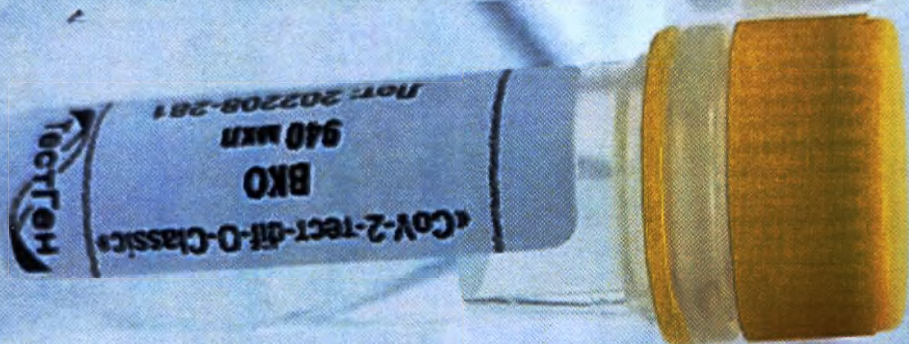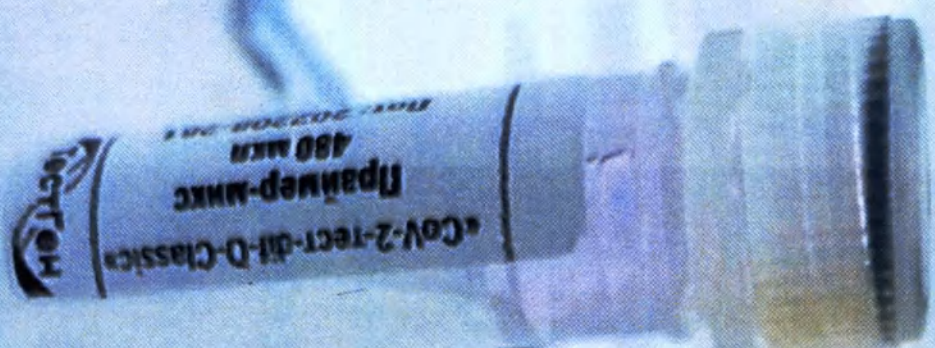

Набор реагентов для качественного выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 и определения делеции DEL31-33 в
гене N, характерной для варианта B. 1.1.529 Omicron, методом
ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-тест-dif-O», партия 202208-281

Форма комплектации 2

Состоит из 2 комплектов. Комплект 2 из 2

Комплект реагентов для экстракции
РНК для ручного выделения «НК-Экстра-SW»

LOT	202208-281	Состав комплекта:	
	2022-08	Буфер для связывания	1 флакон, 48 мл
		Магнитные частицы	1 пробирка, 900 мкл
	2024-02	Раствор для промывки	1 флакон, 68 мл
		Элюент	1 флакон, 10 мл

95

«Col»



IVD

РУ /
Только для *in vitro* диагностики
Только для профессионального применения

ООО «ТестГен»
437072 Россия, г. Ульяновск, 44-й Индустриальный проезд,
дом 9, офис 13

Тел.: +7(499)705-03-75
info@testgen.ru
www.testgen.ru



281



2024-02




2022-08-281



2024-02



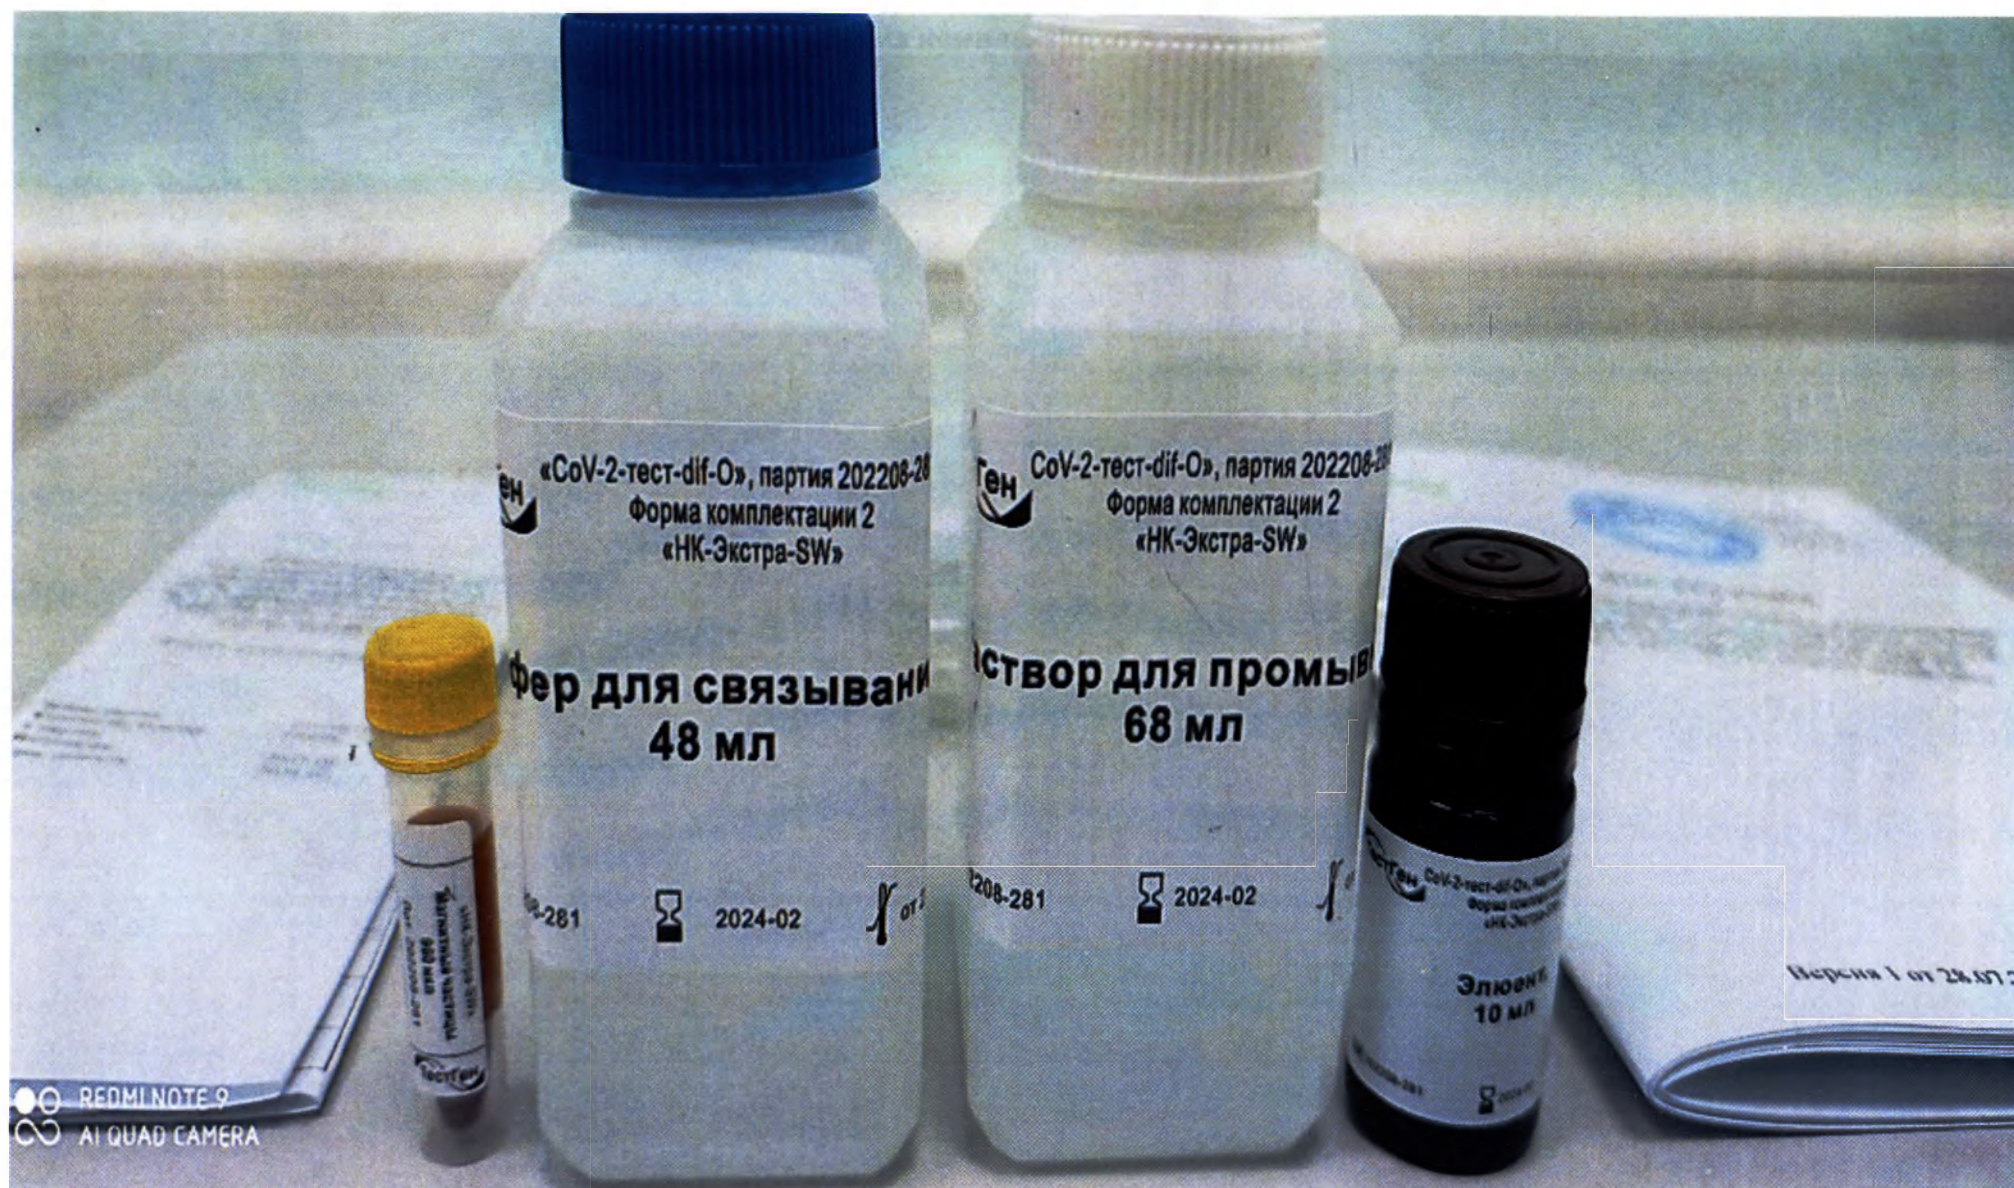

Набор реагентов для качественного выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 и определения делеции DEL31-33 в
гене N, характерной для варианта B. 1.1.529 Omicron, методом
ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-тест-dif-O», партия 202208-281

Форма комплектации 3

Комплект реагентов для ОТ-ПЦР «CoV-2-тест-dif-O-Cito»

LOT 202208-281



2022-08



2024-02



94



Состав набора:

ОТ-ПЦР-буфер-Cito 5x	1 пробирка, 480 мкл
Праймер-микс	1 пробирка, 480 мкл
ПКО	1 пробирка, 225 мкл
ОКО	1 пробирка, 225 мкл
ВКО	1 пробирка, 940 мкл

РУ

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального применения

ООО «ТестГен»

432072 Россия, г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд,
дом 9, офис 13



Тел.: +7(499)785-83-75


info@testgen.ru

www.testgen.ru



Genetium

«CoV-2-тест-dif-O-Cito»
Праймер-микс
480 мкл
Лот: 202208-281
ТестГен

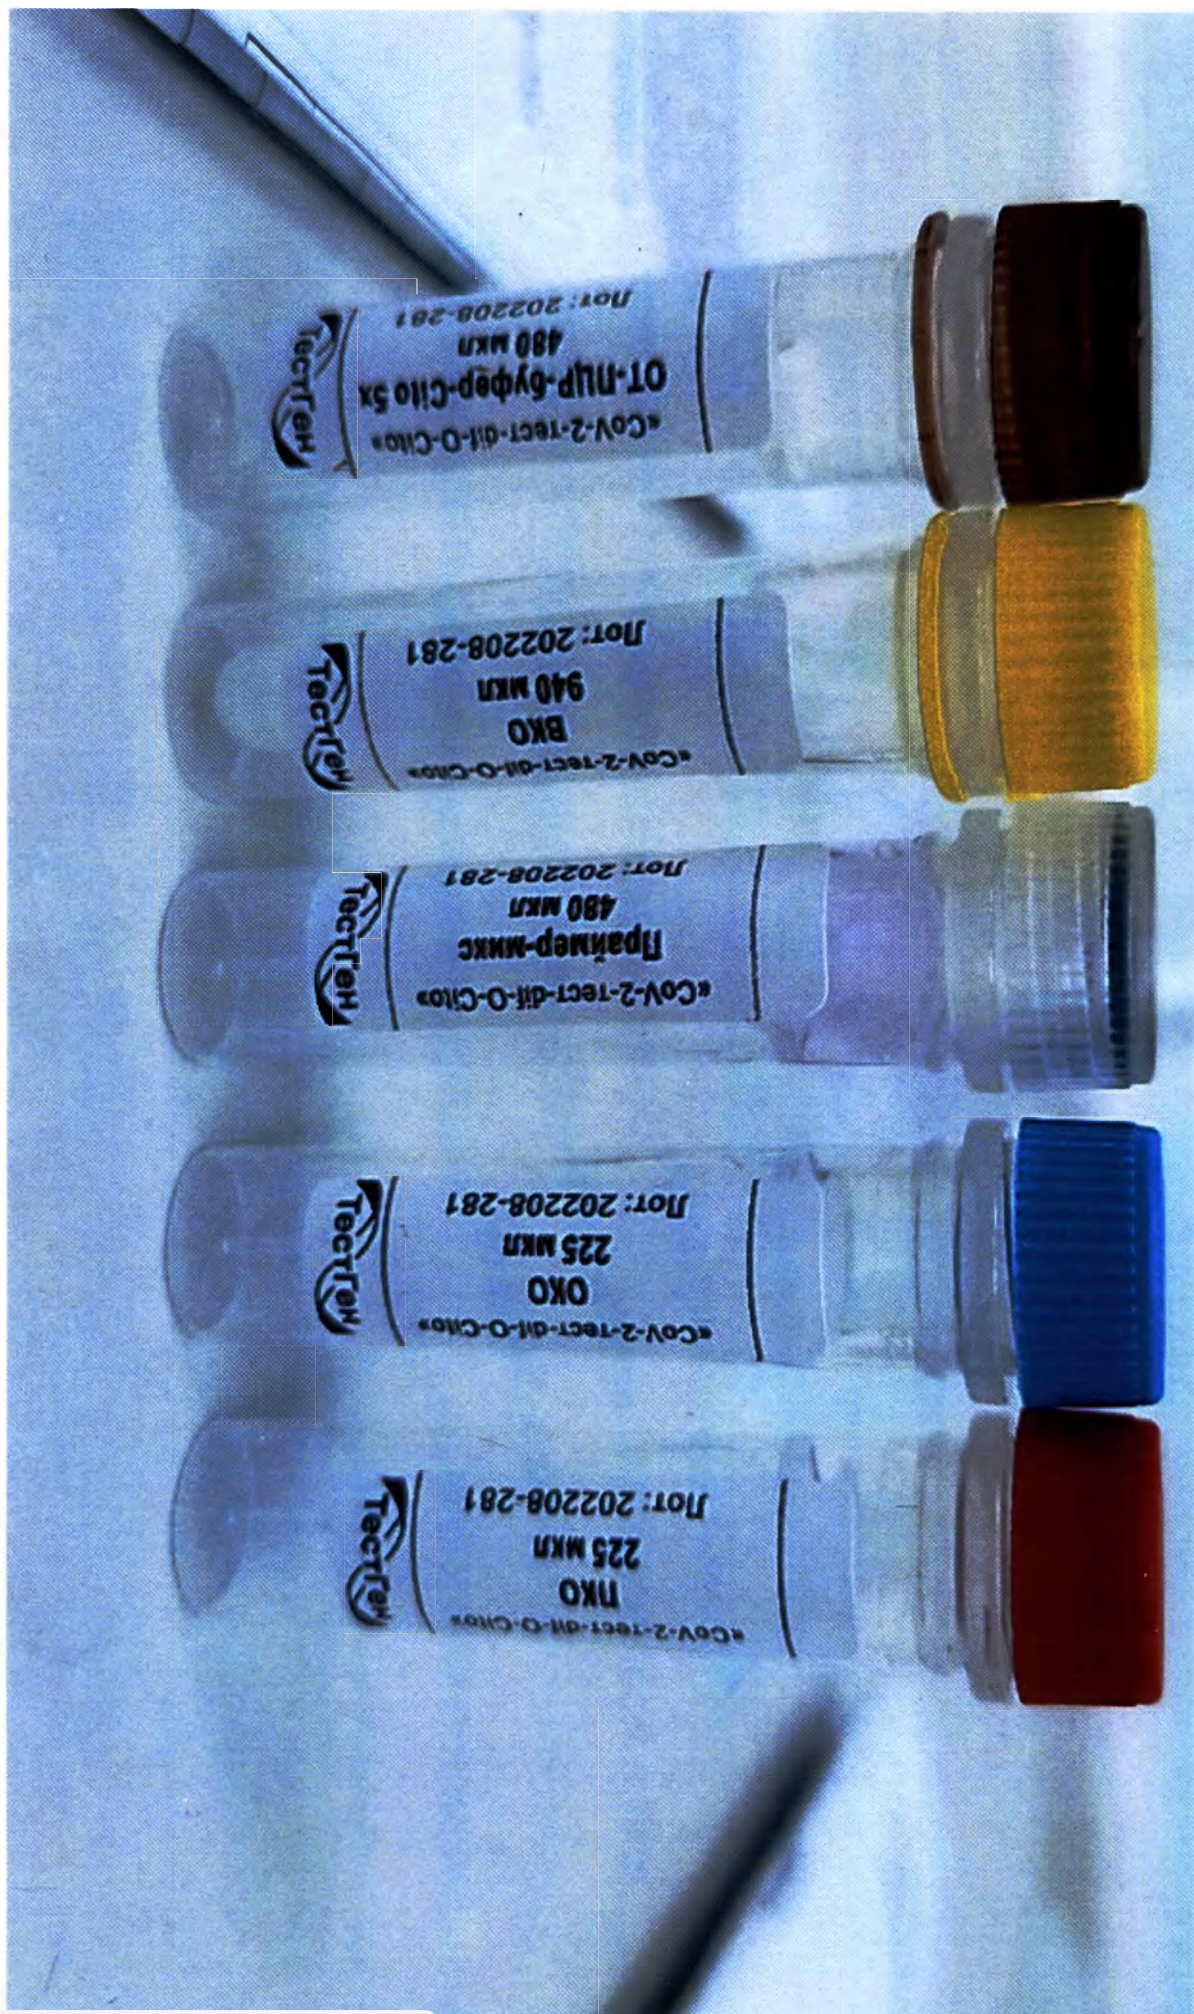

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 8 / восемь лист 8

Директор ГБУЗ «ДЦЛИ ДЗМ»
А.Г. Комаров

«1» октября 2022 г.