

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СП Минимакс»



Р.М. Ахлакова

2023г.

Внешний вид

медицинского изделия Допплерограф ультразвуковой компьютеризированный

для исследования кровотока ММ-Д-К

«Минимакс-доплер-К»

.(фотографические изображения)

На 36 листах

ТУ 26.60.12-002-20819831-2021



Рисунок 1 – Допплерограф ультразвуковой компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-доплер-К», прибор исполнение 01



Рисунок 2 – Блок системный с установленными устройством согласующим (УС) и
предустановленным РПО, вид спереди



Рисунок 3 – Блок системный с установленными устройствам согласующим (УС) и предустановленным РПО, вид сбоку

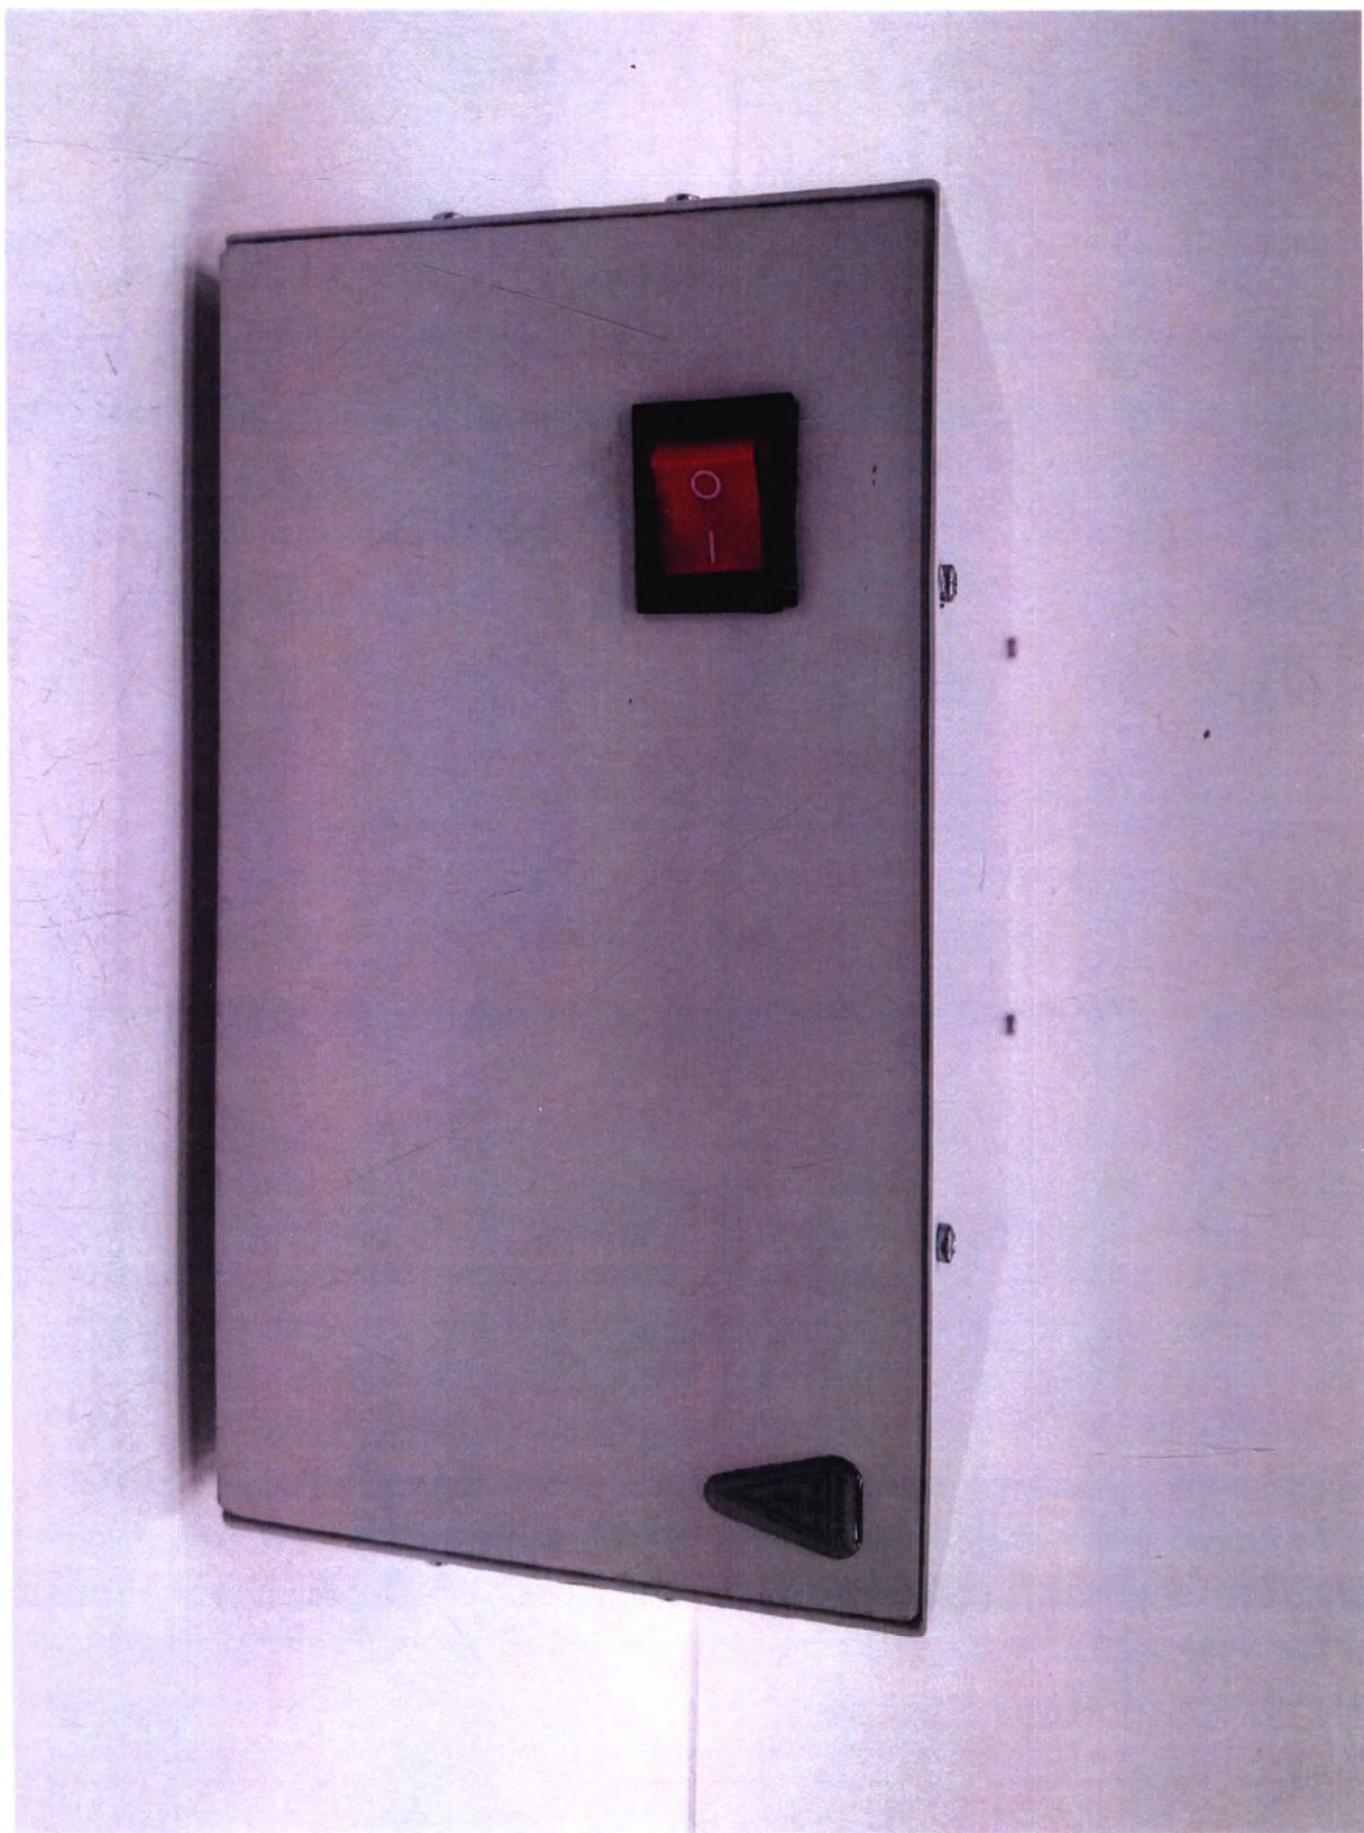


Рисунок 4 – Блок трансформации (БТ) с установленными предохранителями 3А (2 шт.), вид спереди

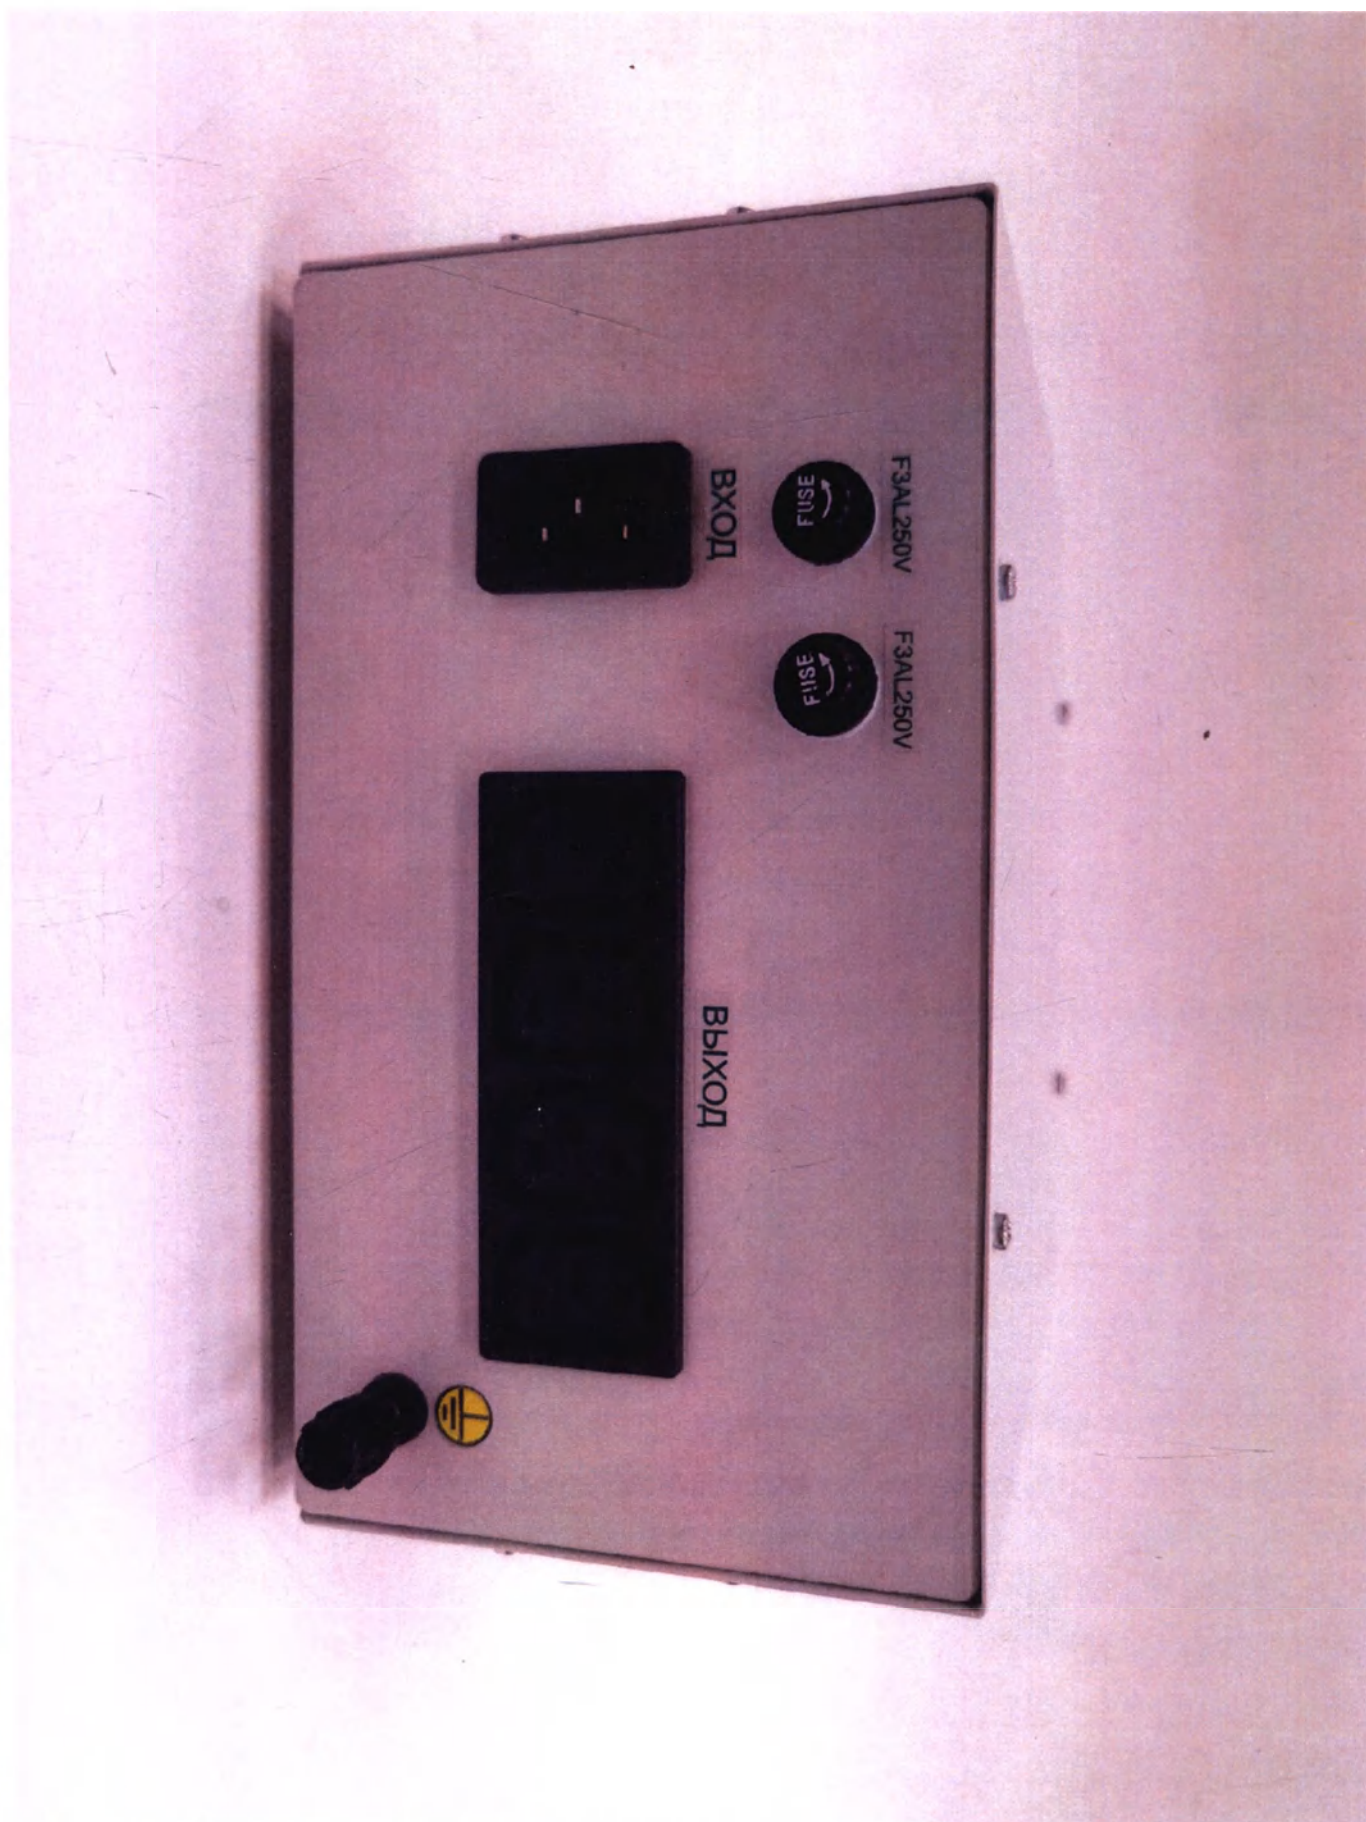


Рисунок 5 – Блок трансформации (БТ) с установленными предохранителями 3А (2 шт.), вид сзади

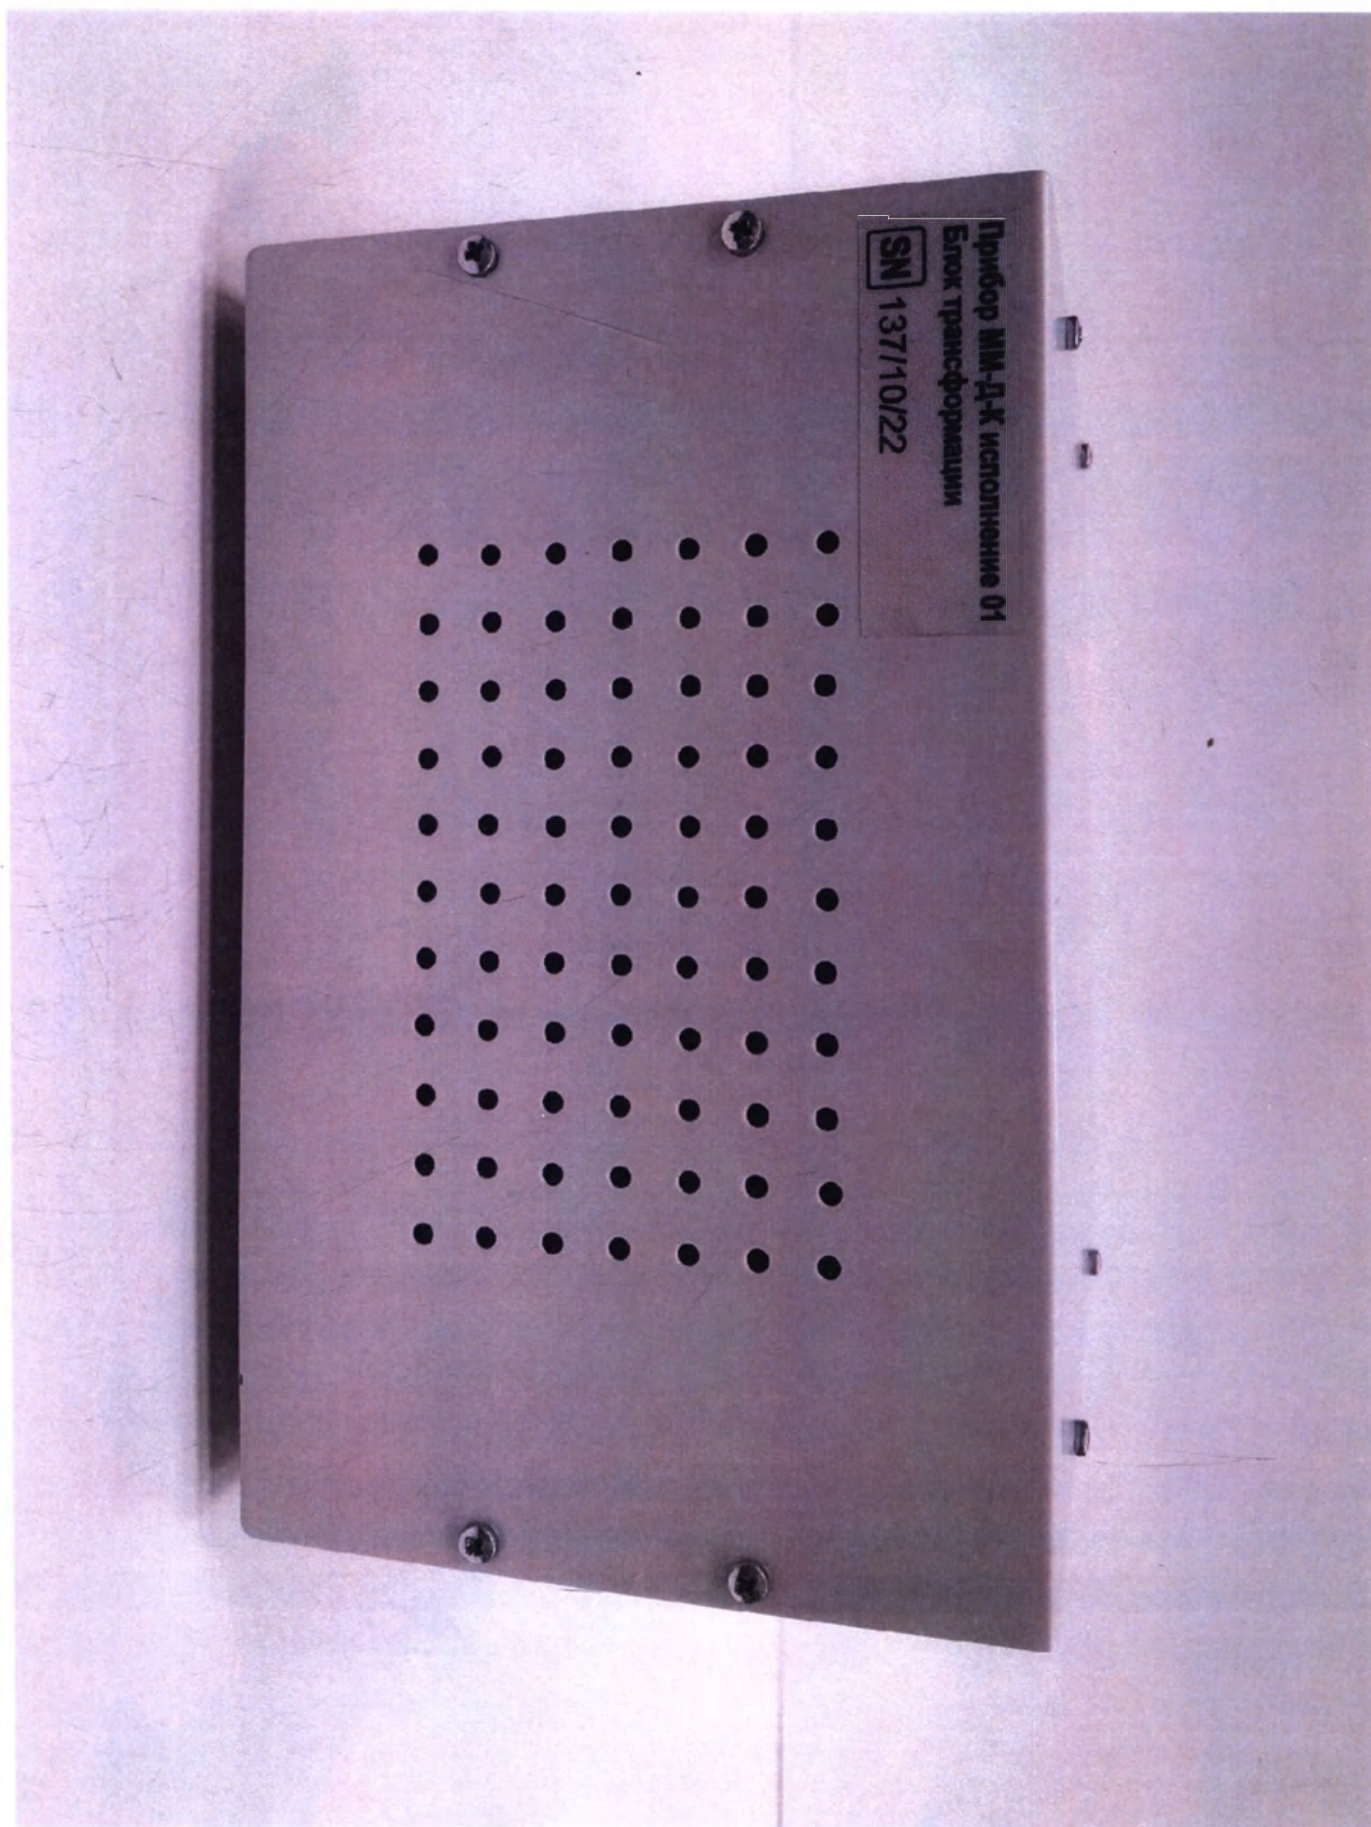


Рисунок 6 – Блок трансформации (БТ) с установленными предохранителями 3А (2 шт.), вид сбоку

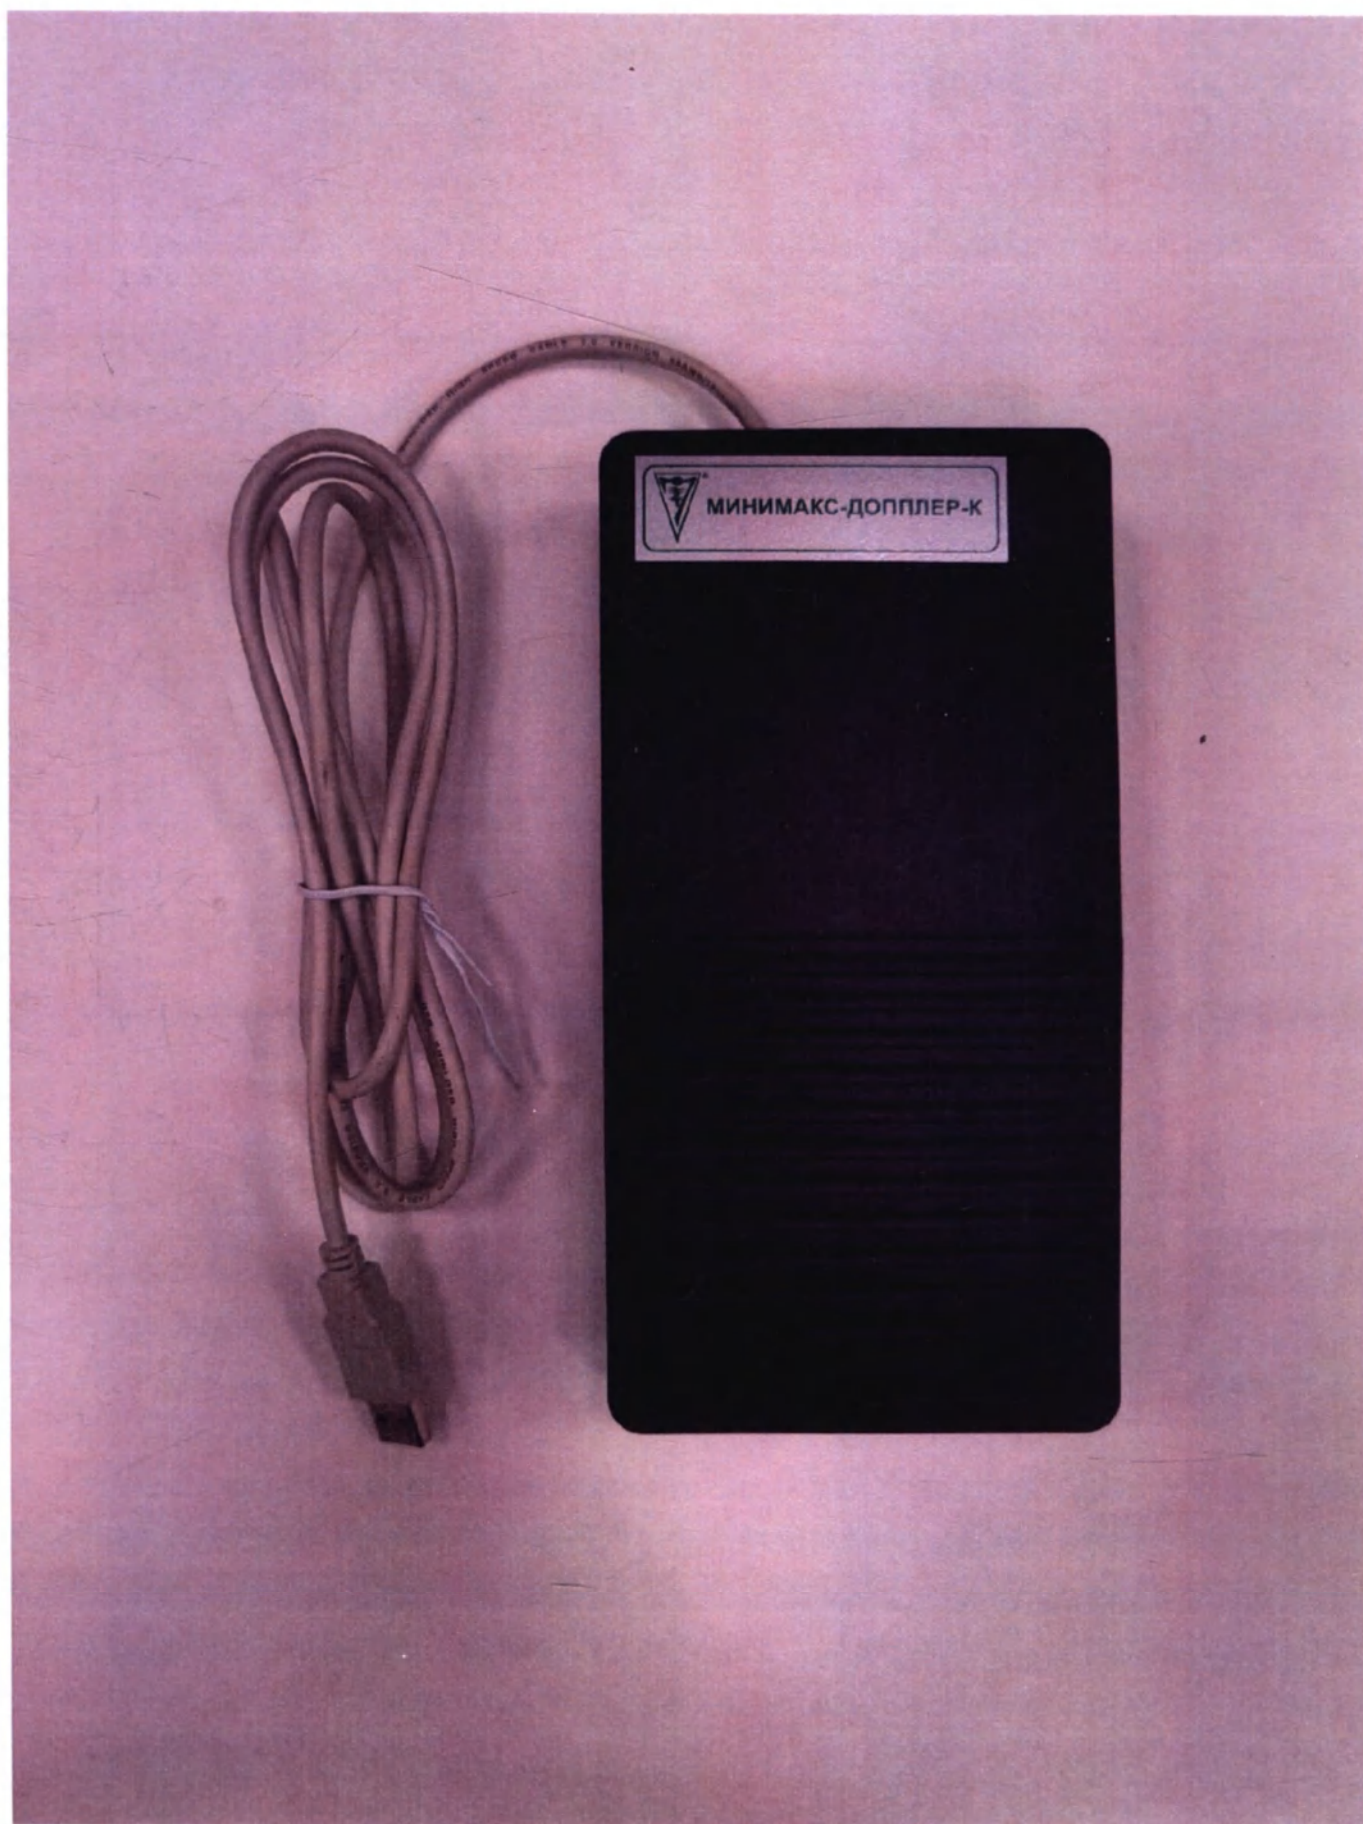


Рисунок 7 – Ножной переключатель (педаль), вид спереди

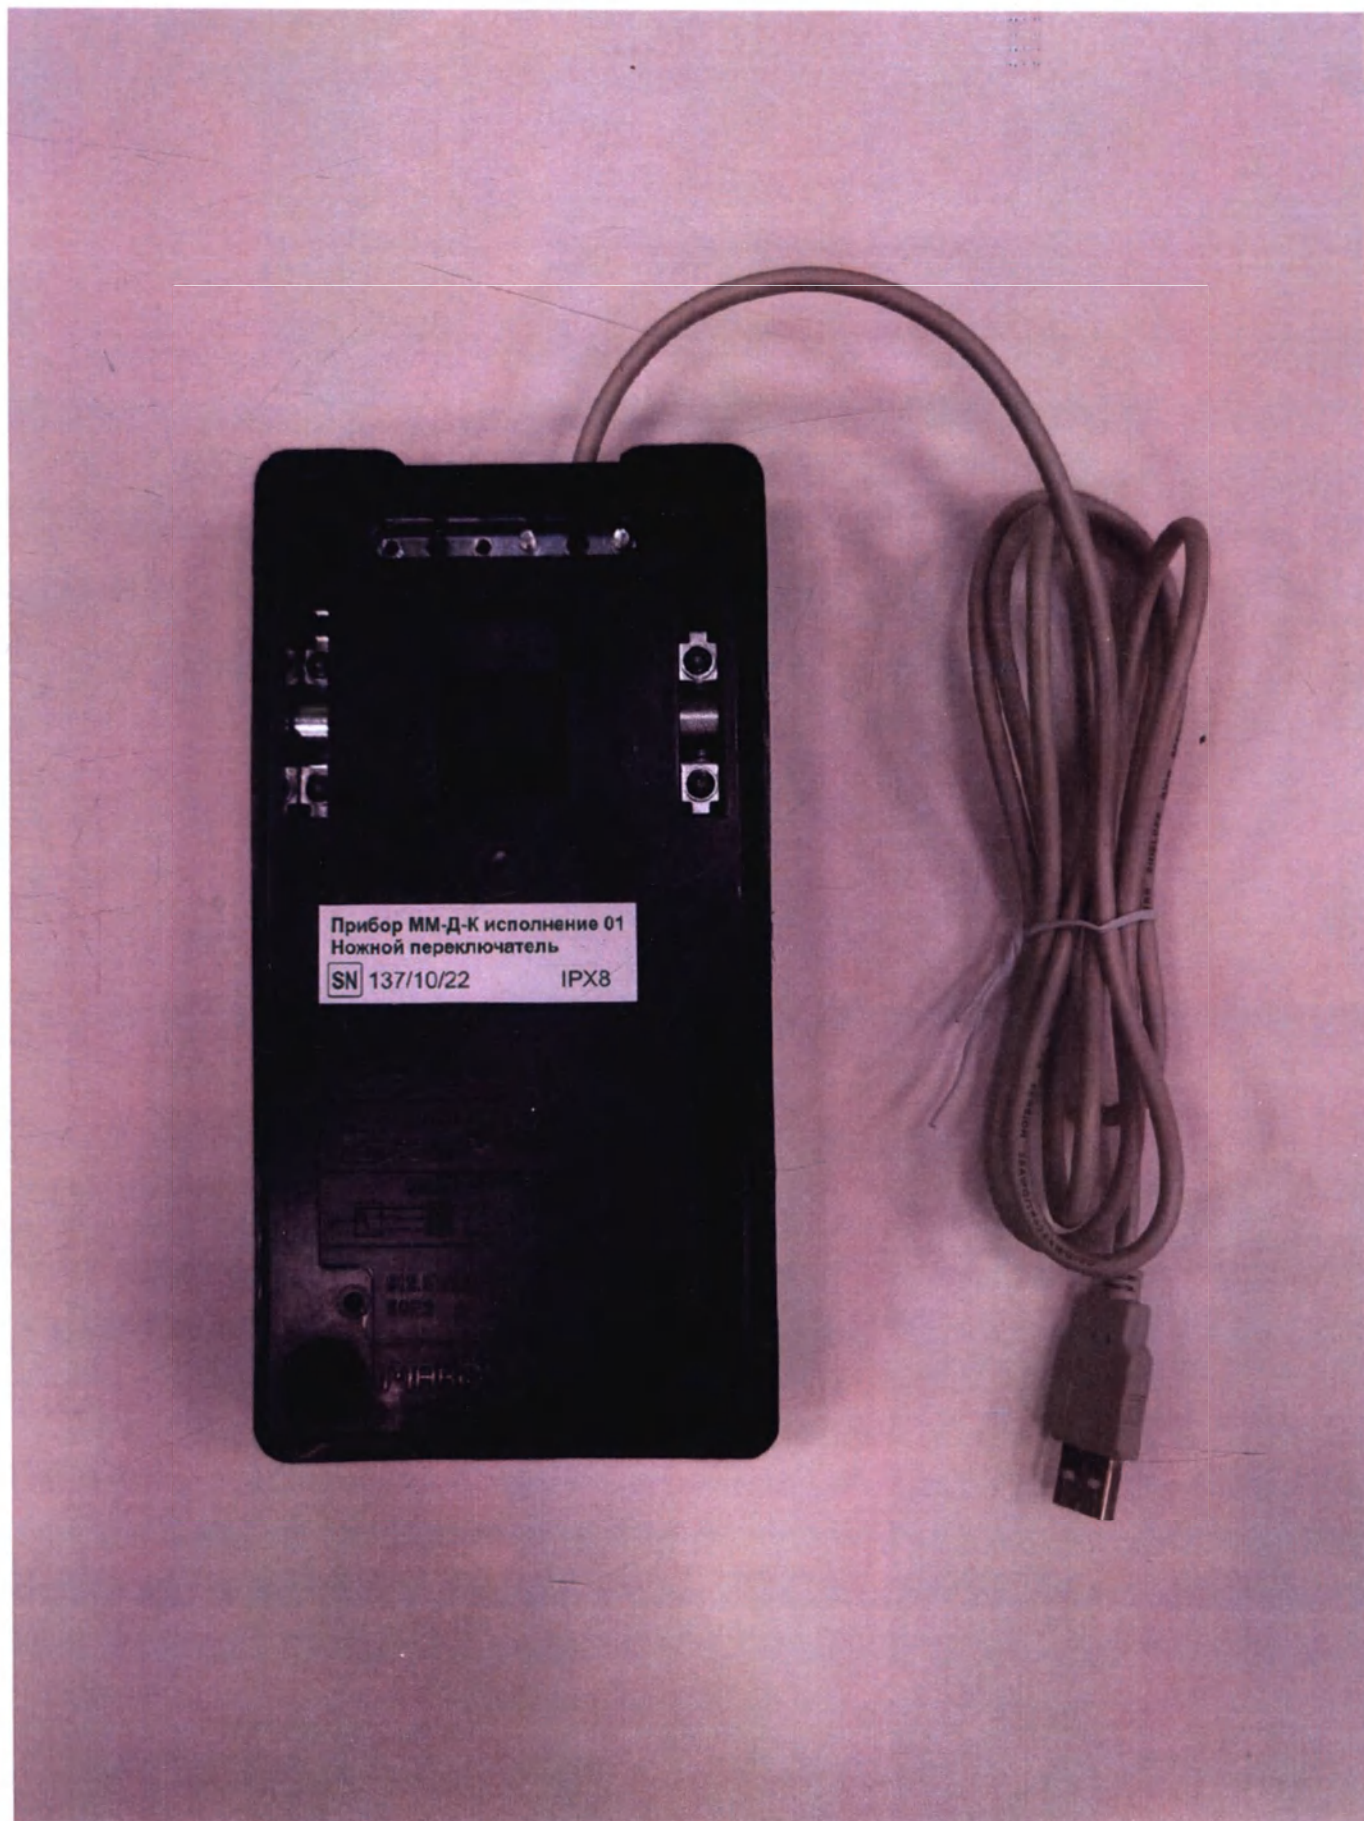


Рисунок 8 – Ножной переключатель (педаль), вид сзади

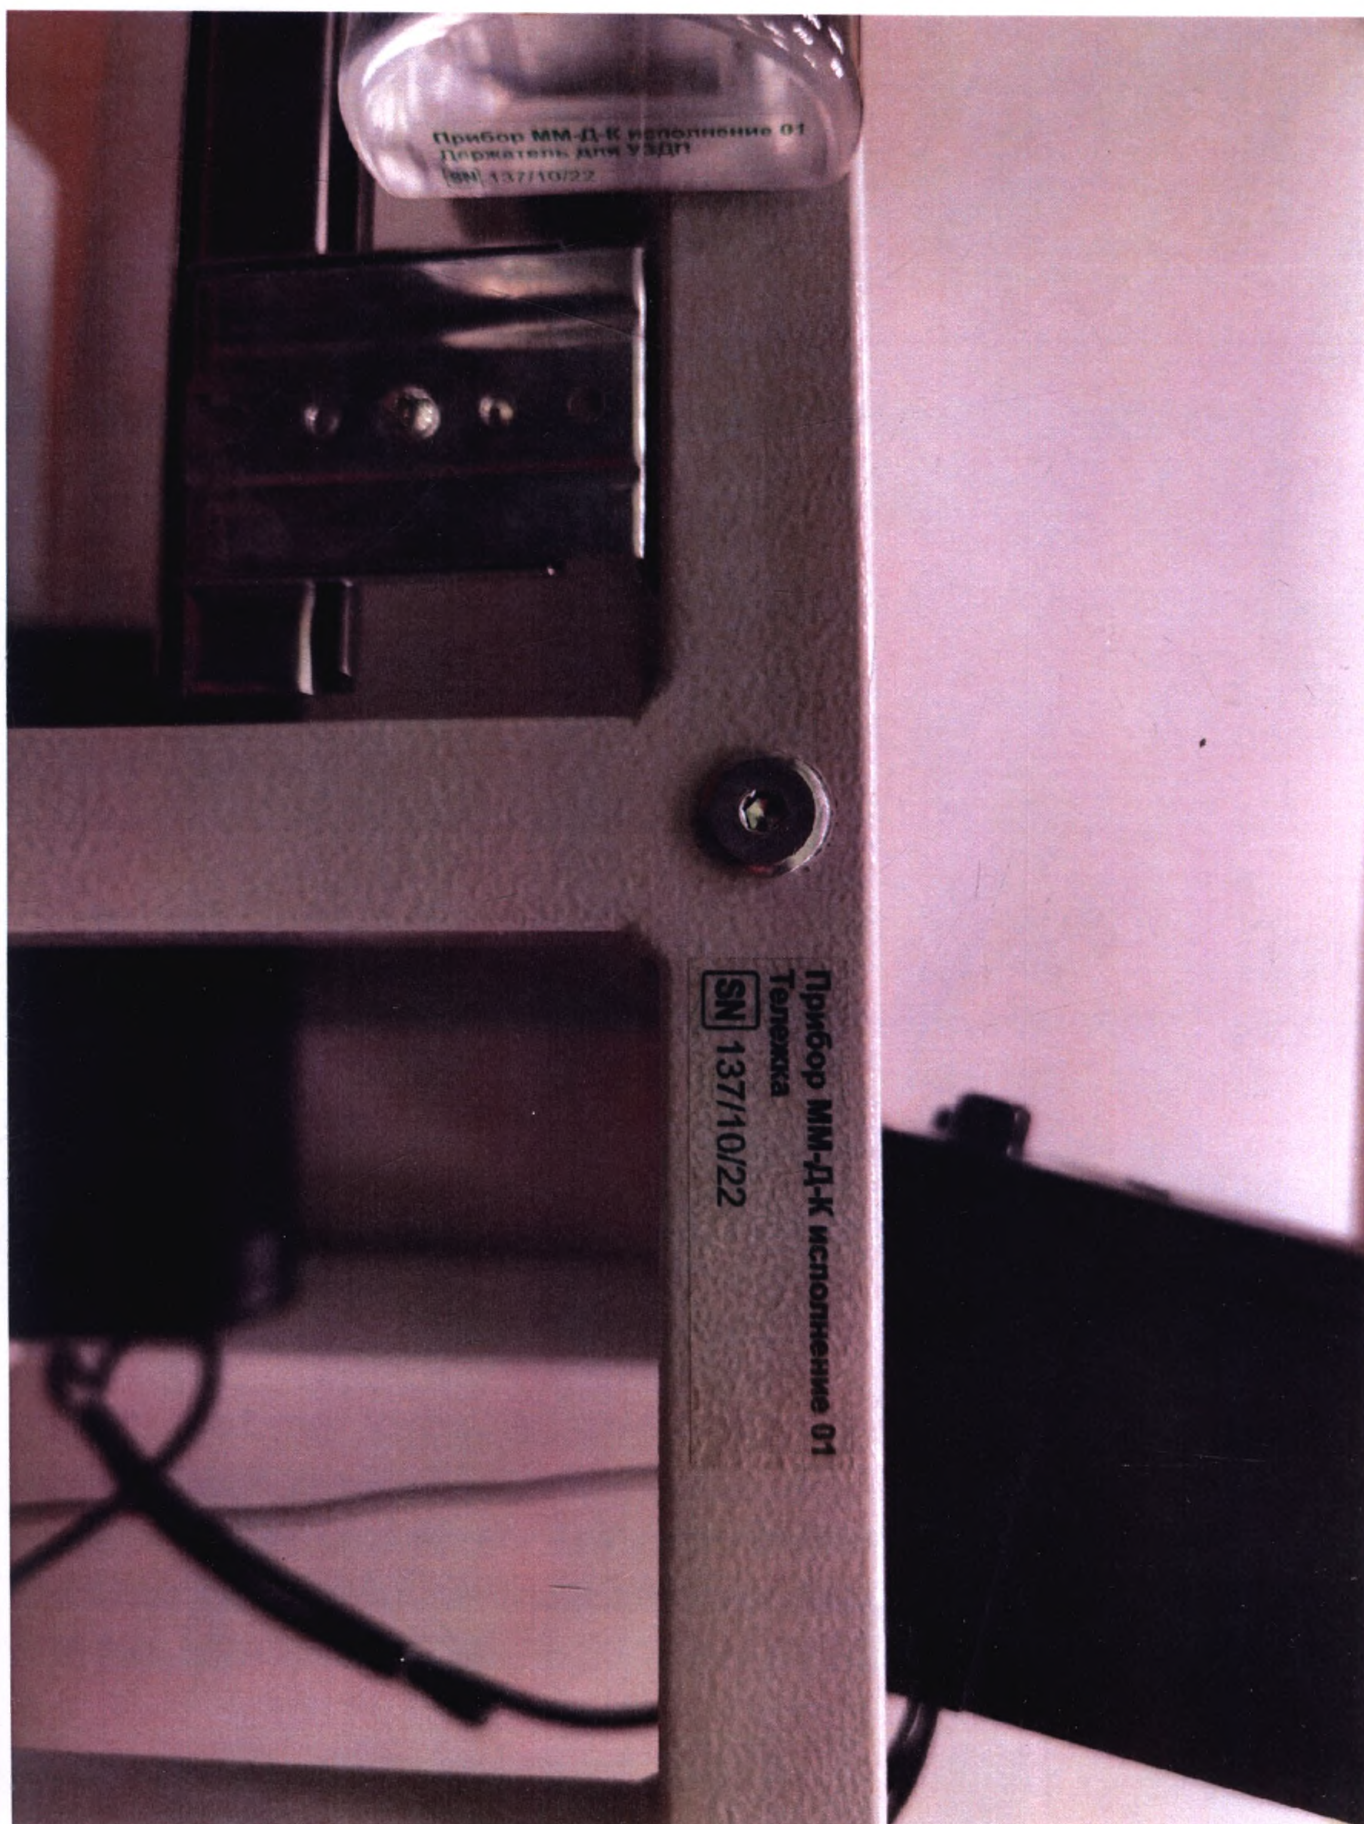


Рисунок 9 – Тележка, маркировка



Рисунок 10 – Держатель для УЗДП, маркировка



Рисунок 11 – Футляры для УЗДП



Рисунок 12 – Футляр для УЗИП, маркировка



Рисунок 13 – Допплерограф ультразвуковой компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-доплер-К», прибор исполнение 01, транспортная упаковка



Рисунок 14 – Допплерограф ультразвуковой компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-доплер-К», прибор исполнение 02

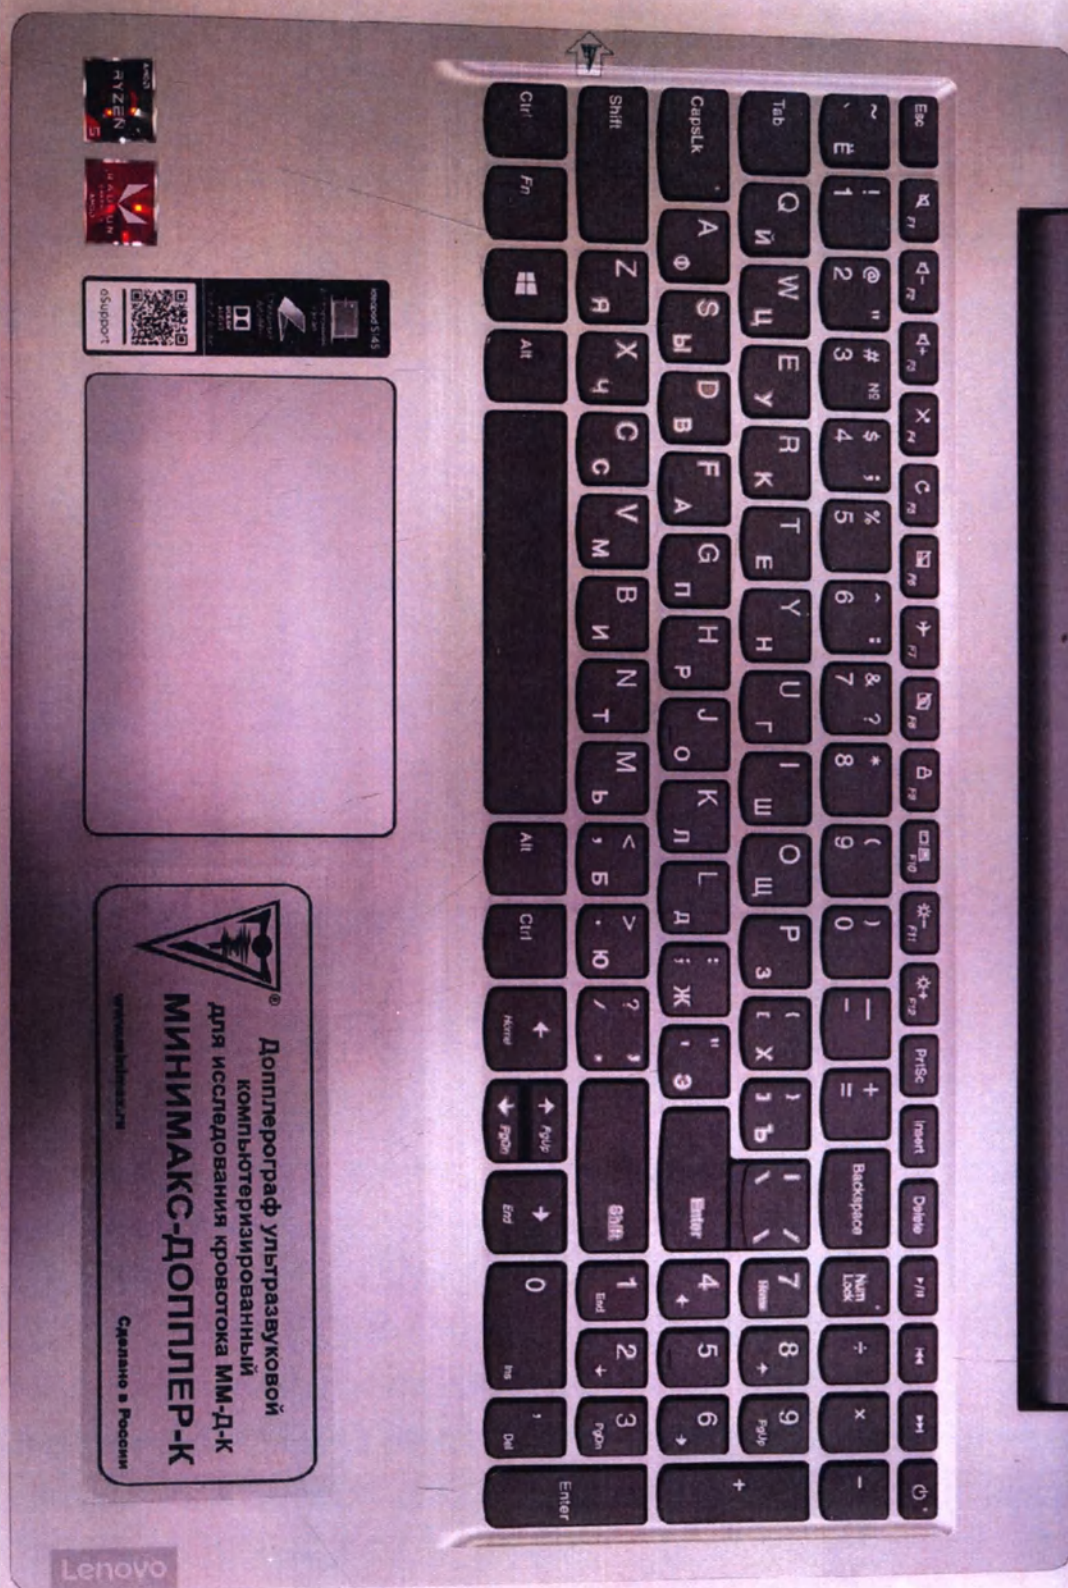


Рисунок 15 – Персональный компьютер в виде ноутбука/нетбука с предустановленным РПО, имеющим источник внутреннего безопасного низкого напряжения, вид спереди

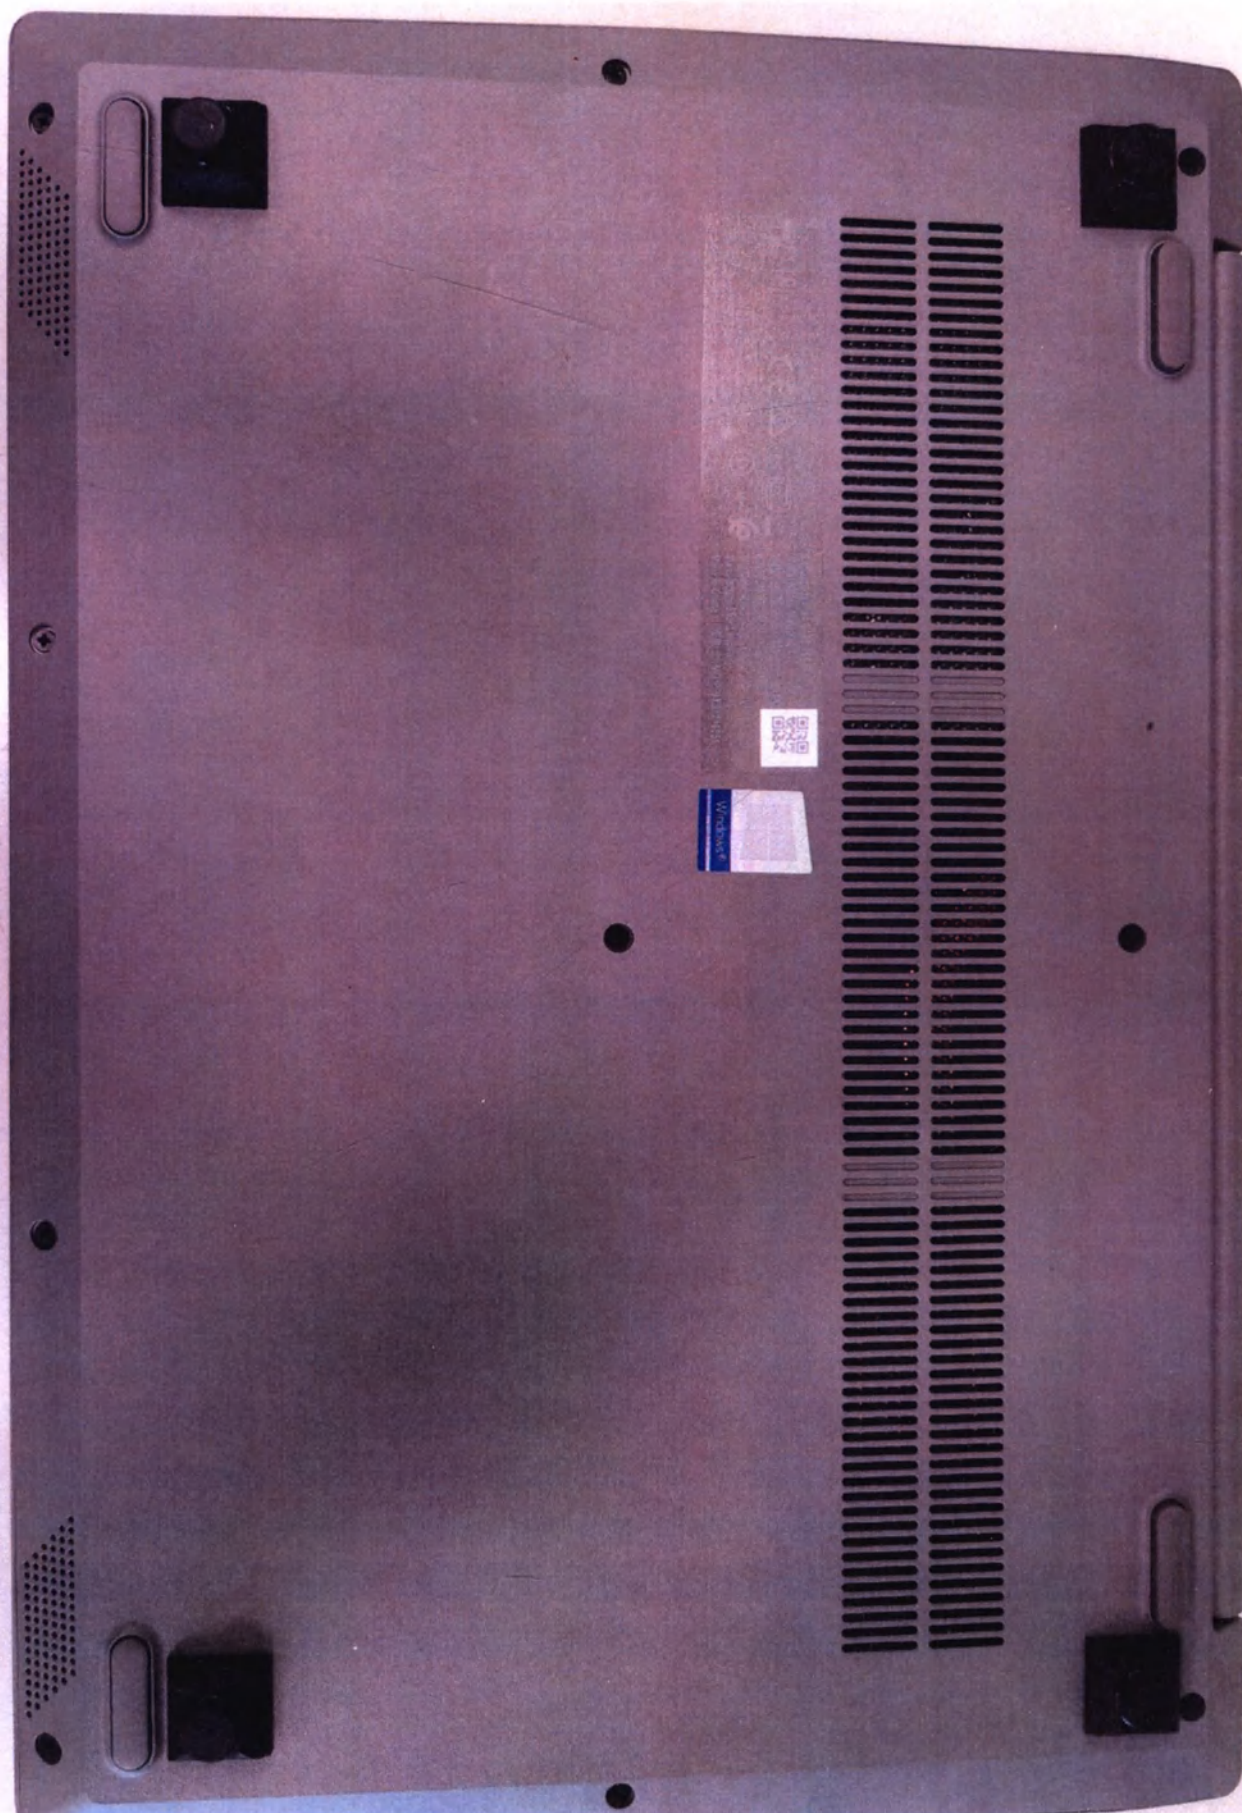


Рисунок 16 – Персональный компьютер в виде ноутбука/нетбука с предустановленным РПО, имеющим источник внутреннего безопасного низкого напряжения, вид сзади

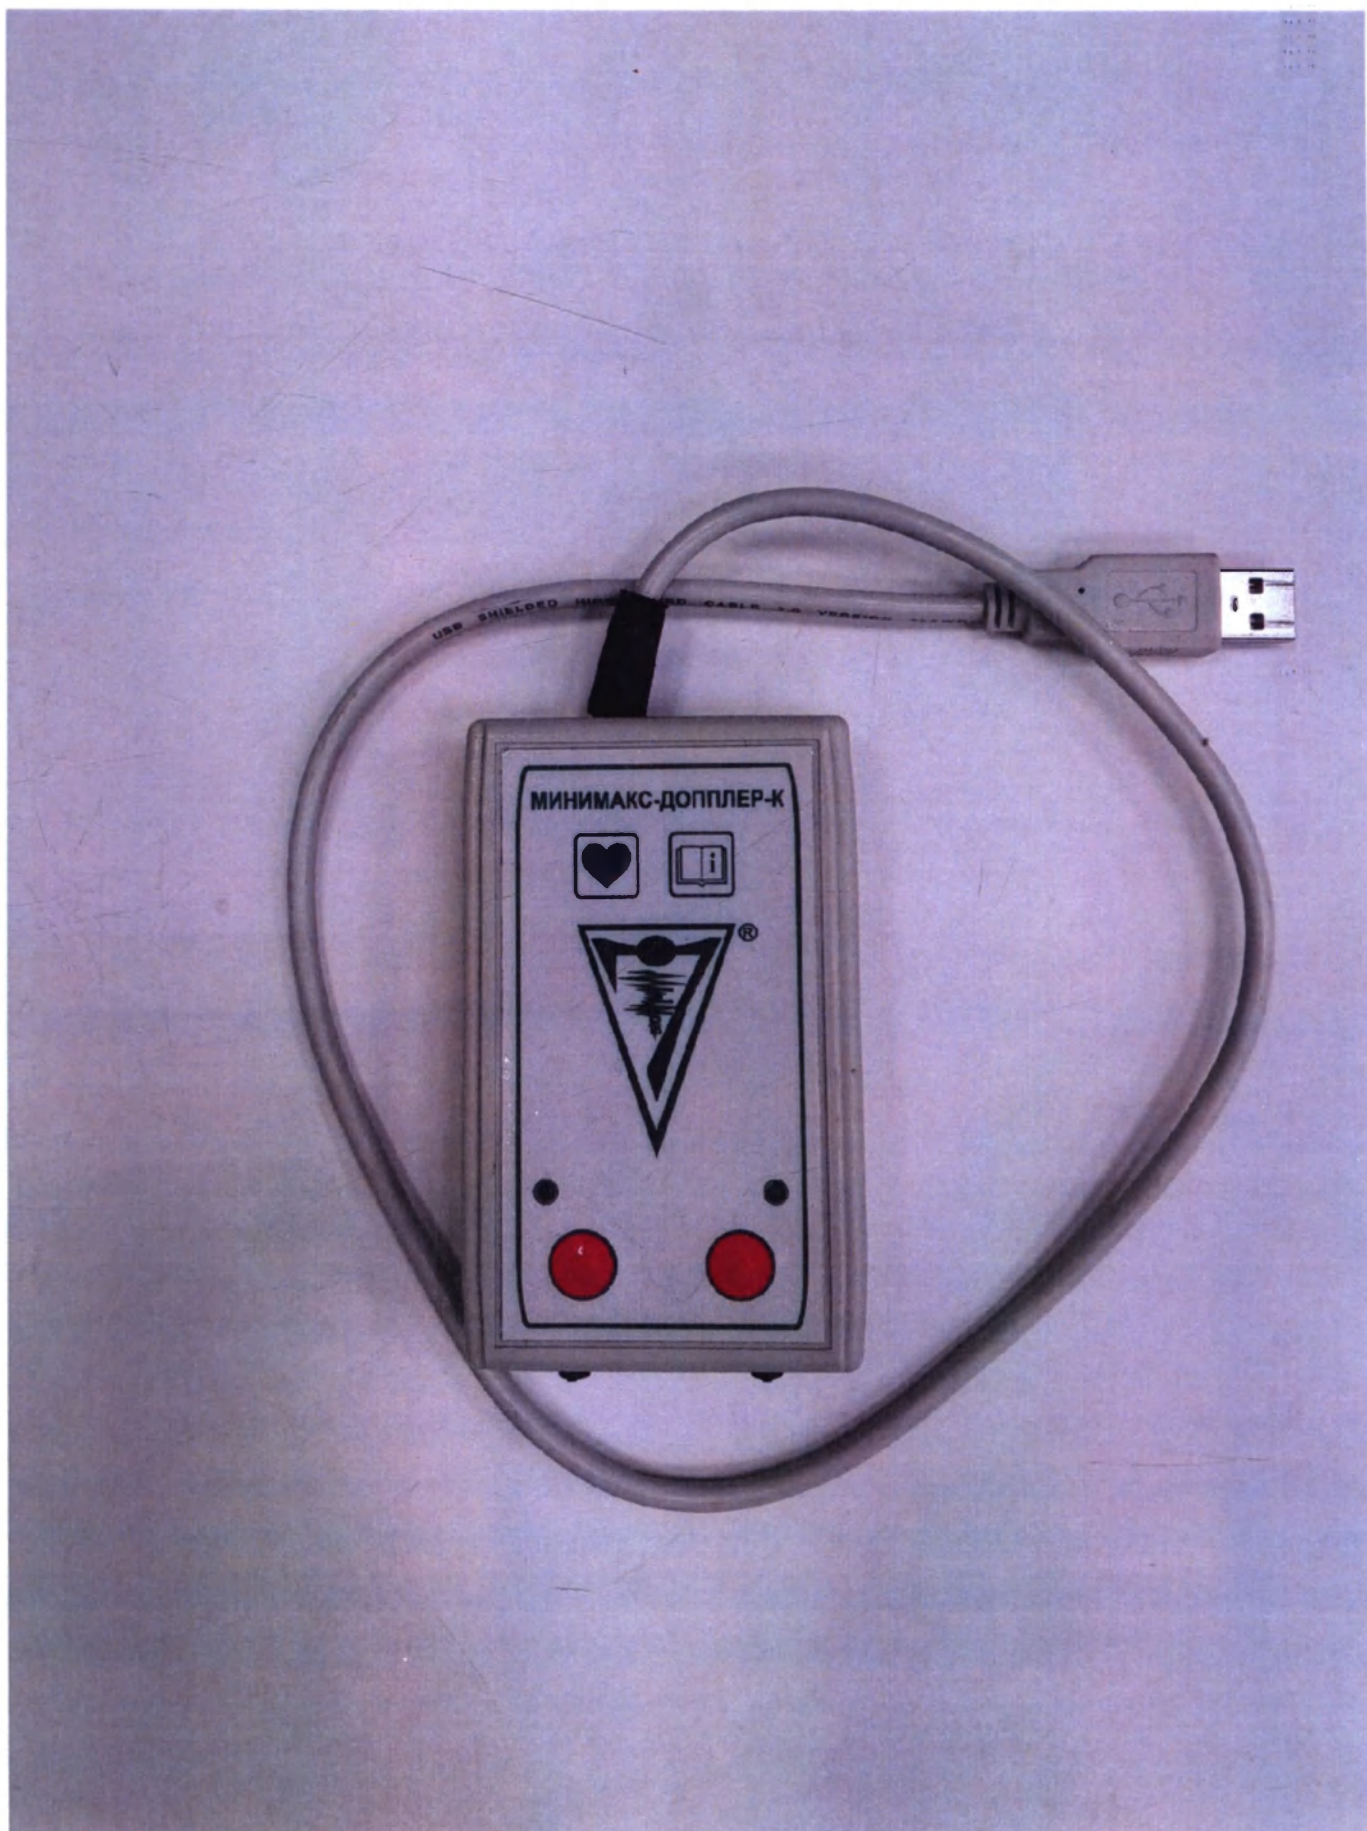


Рисунок 17 – Устройство согласующее, вид спереди



Рисунок 18 – Устройство согласующее, вид сзади

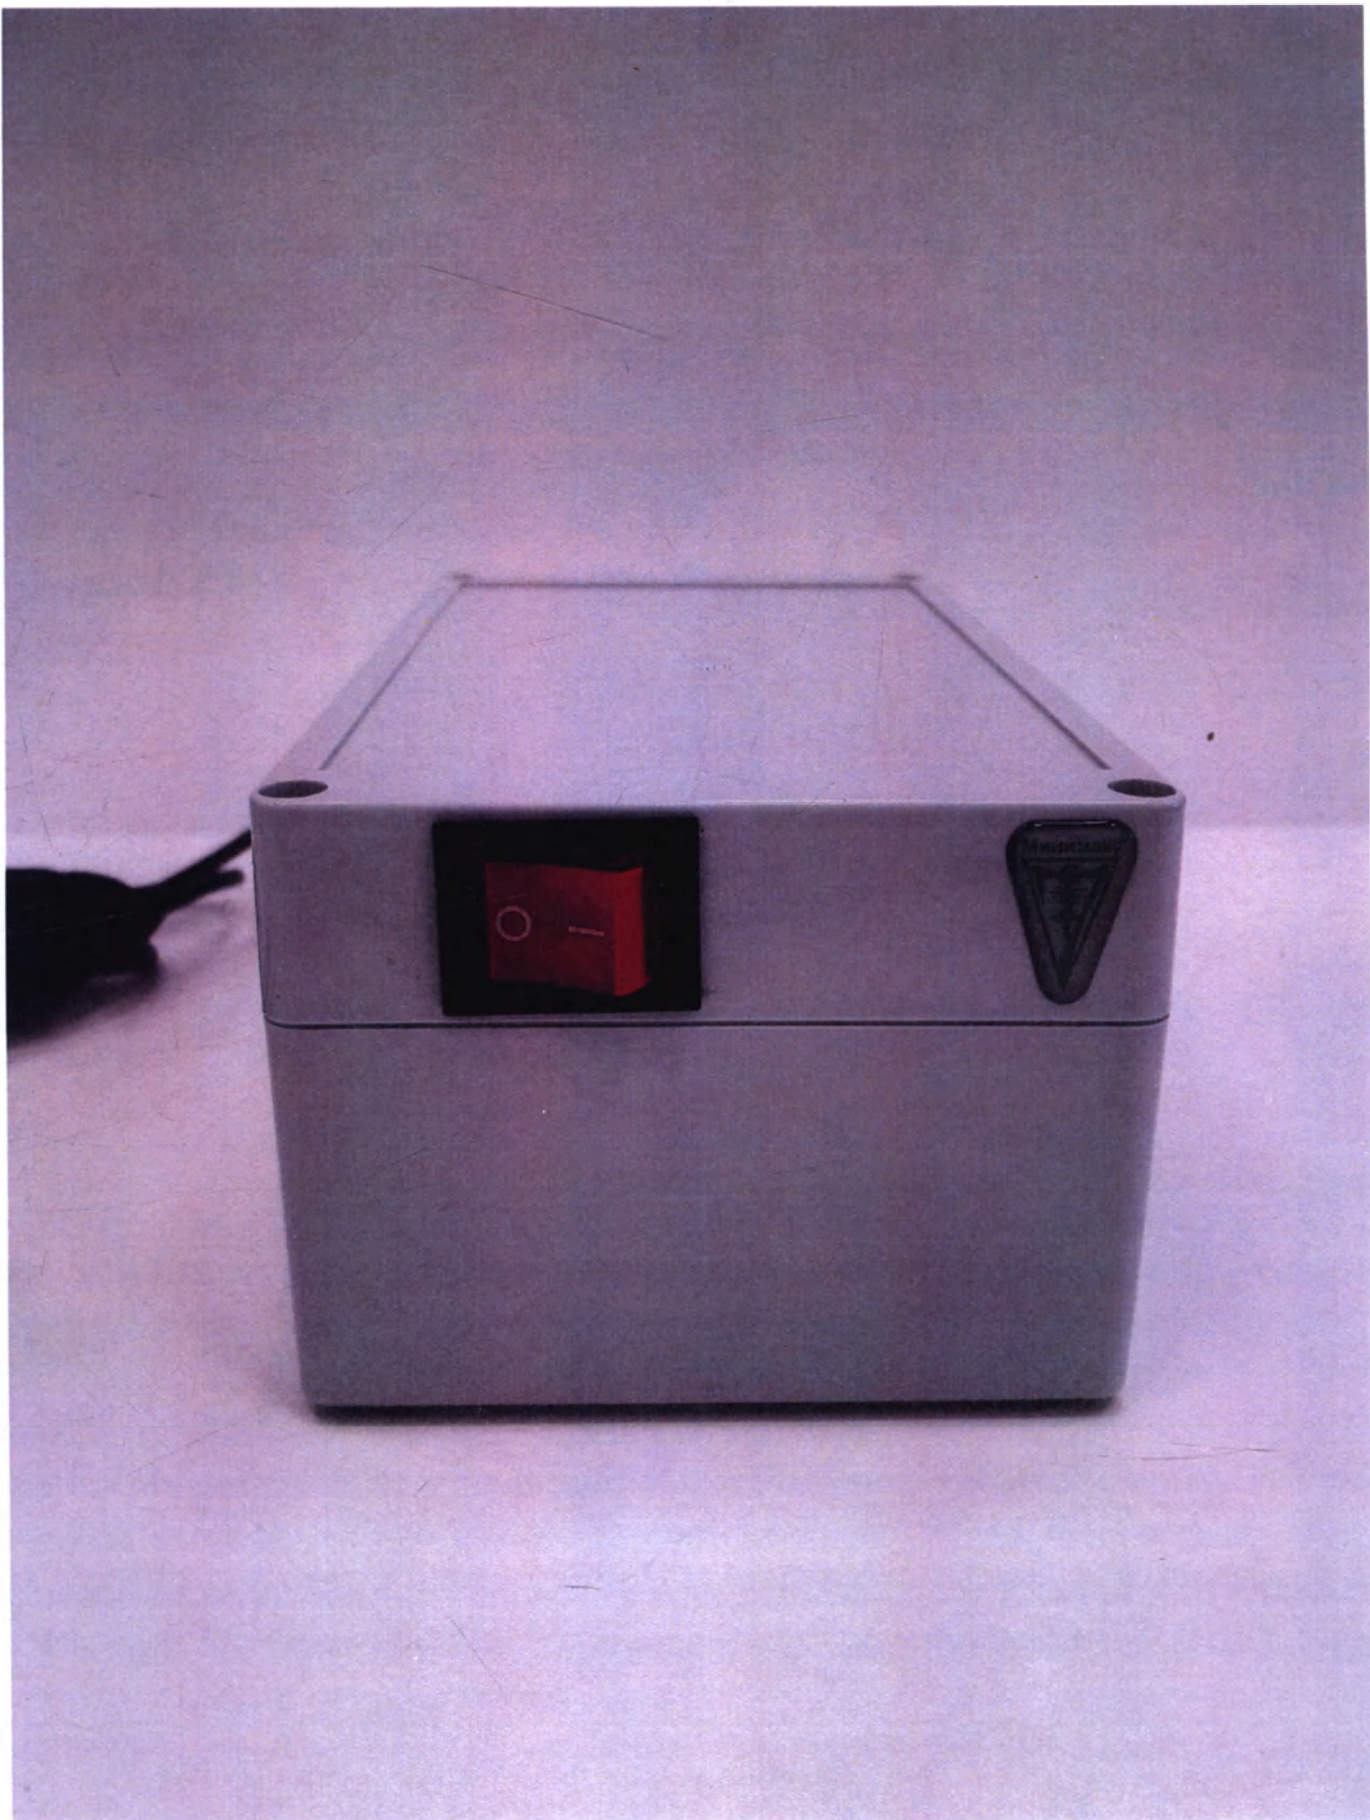


Рисунок 19 – Блок трансформации (БТ) с установленными предохранителями 3А (2 шт.), вид спереди

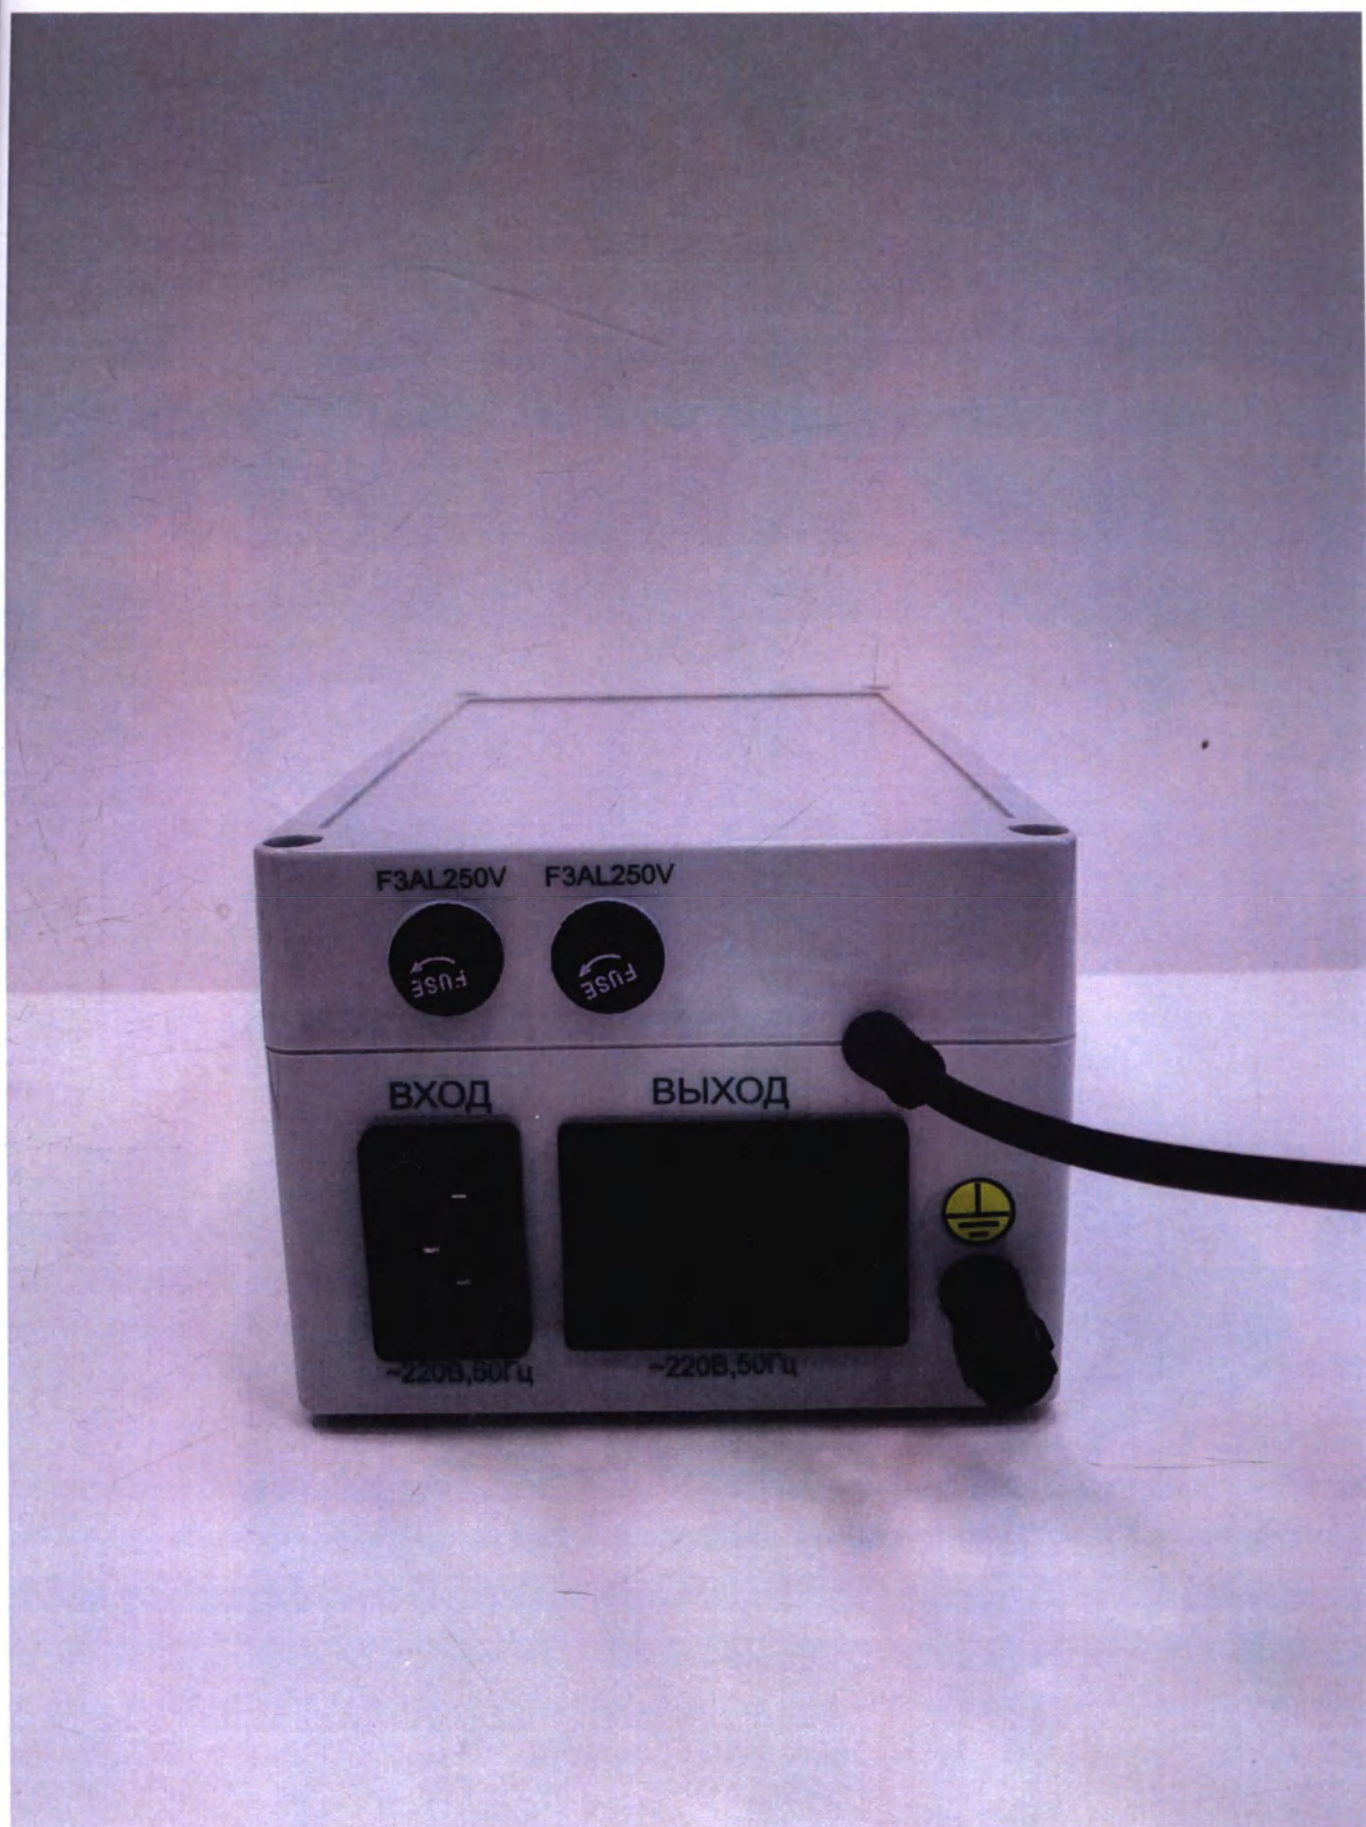


Рисунок 20 – Блок трансформации (БТ) с установленными предохранителями 3А (2 шт.), вид сзади

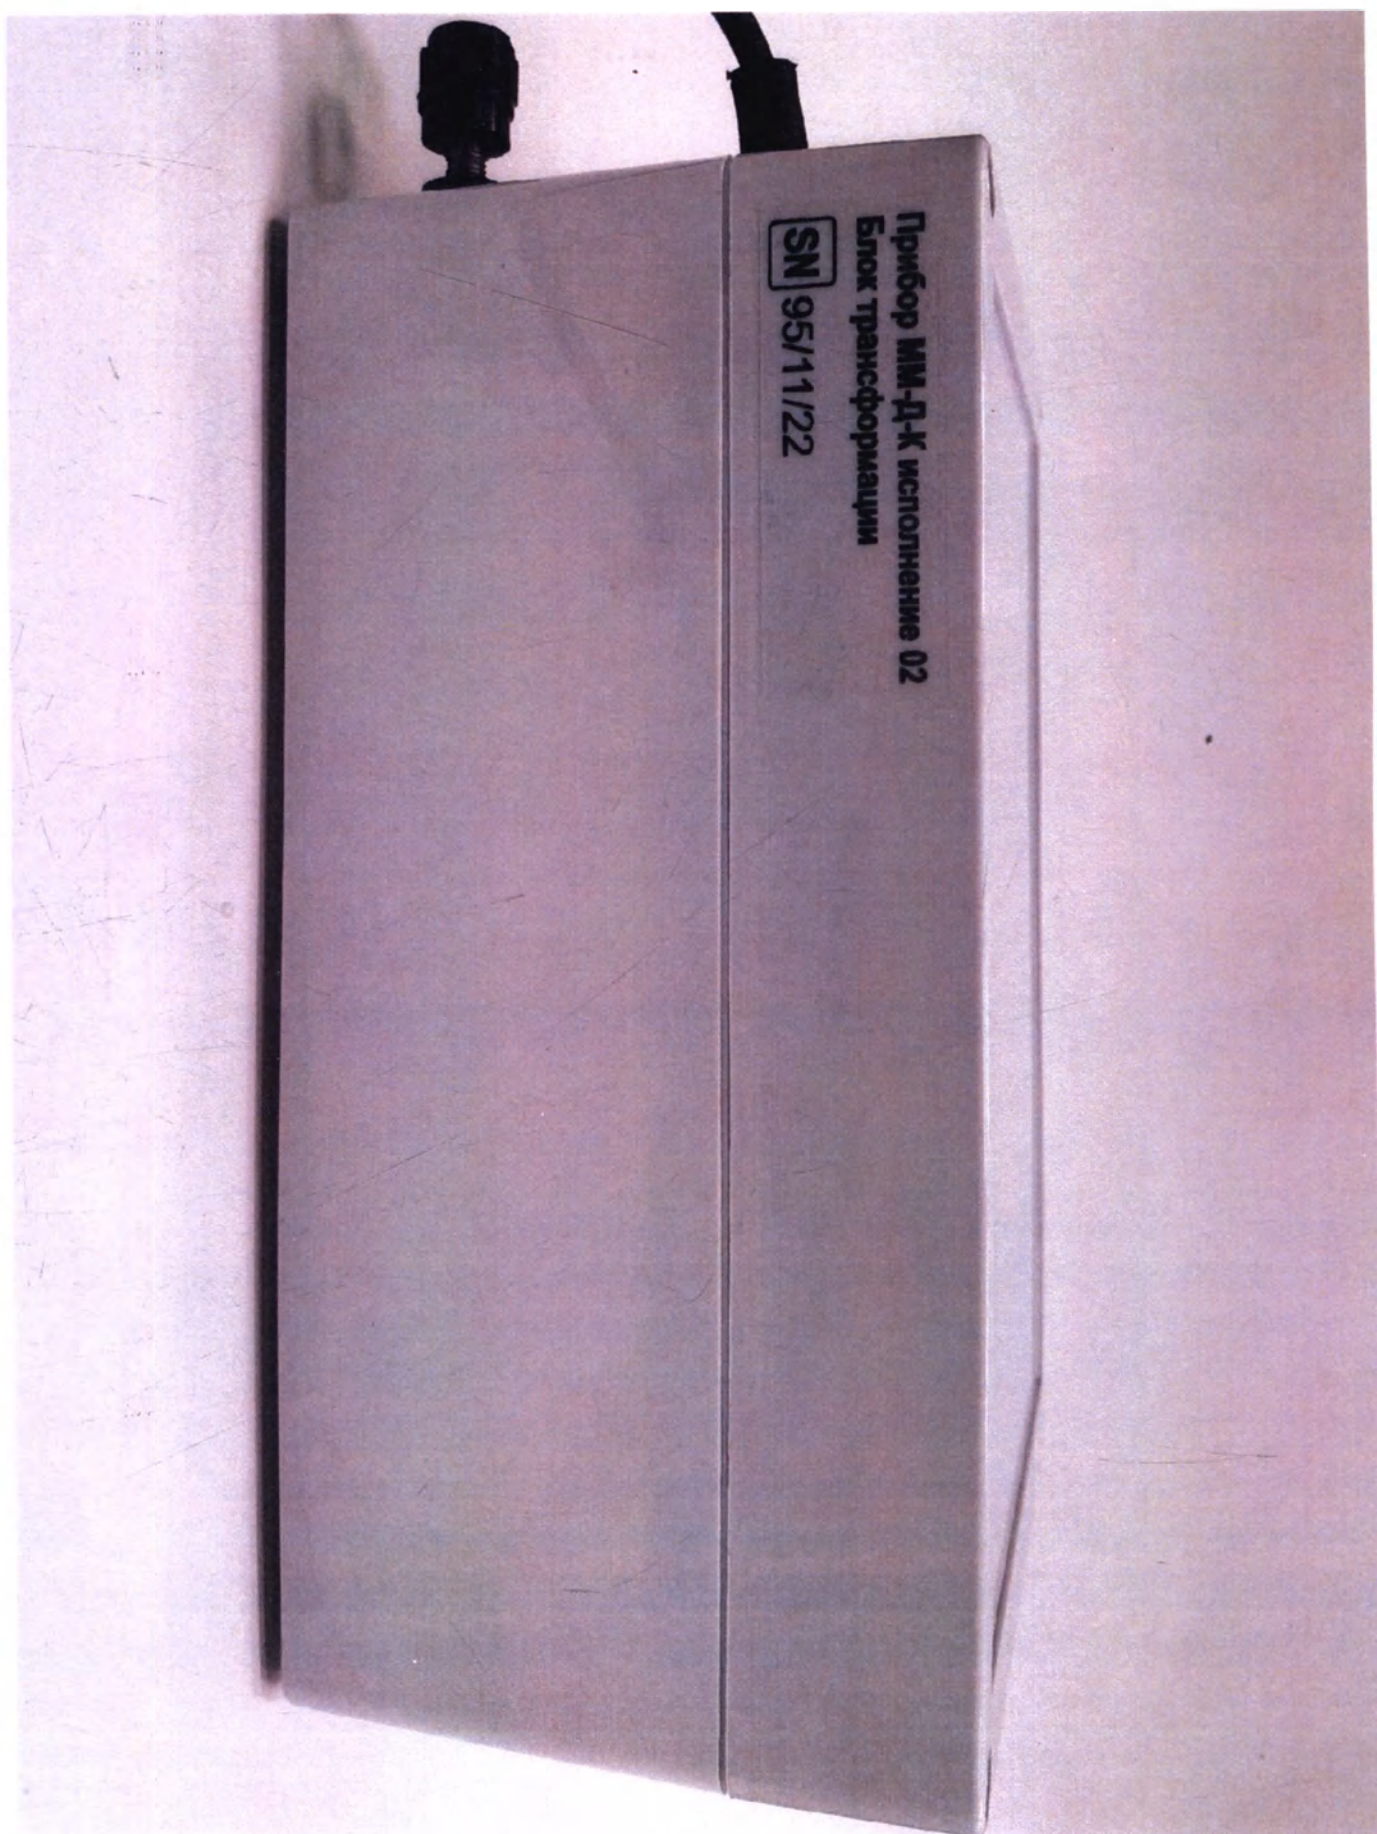


Рисунок 21 – Блок трансформации (БТ) с установленными предохранителями 3А (2 шт.), вид сбоку

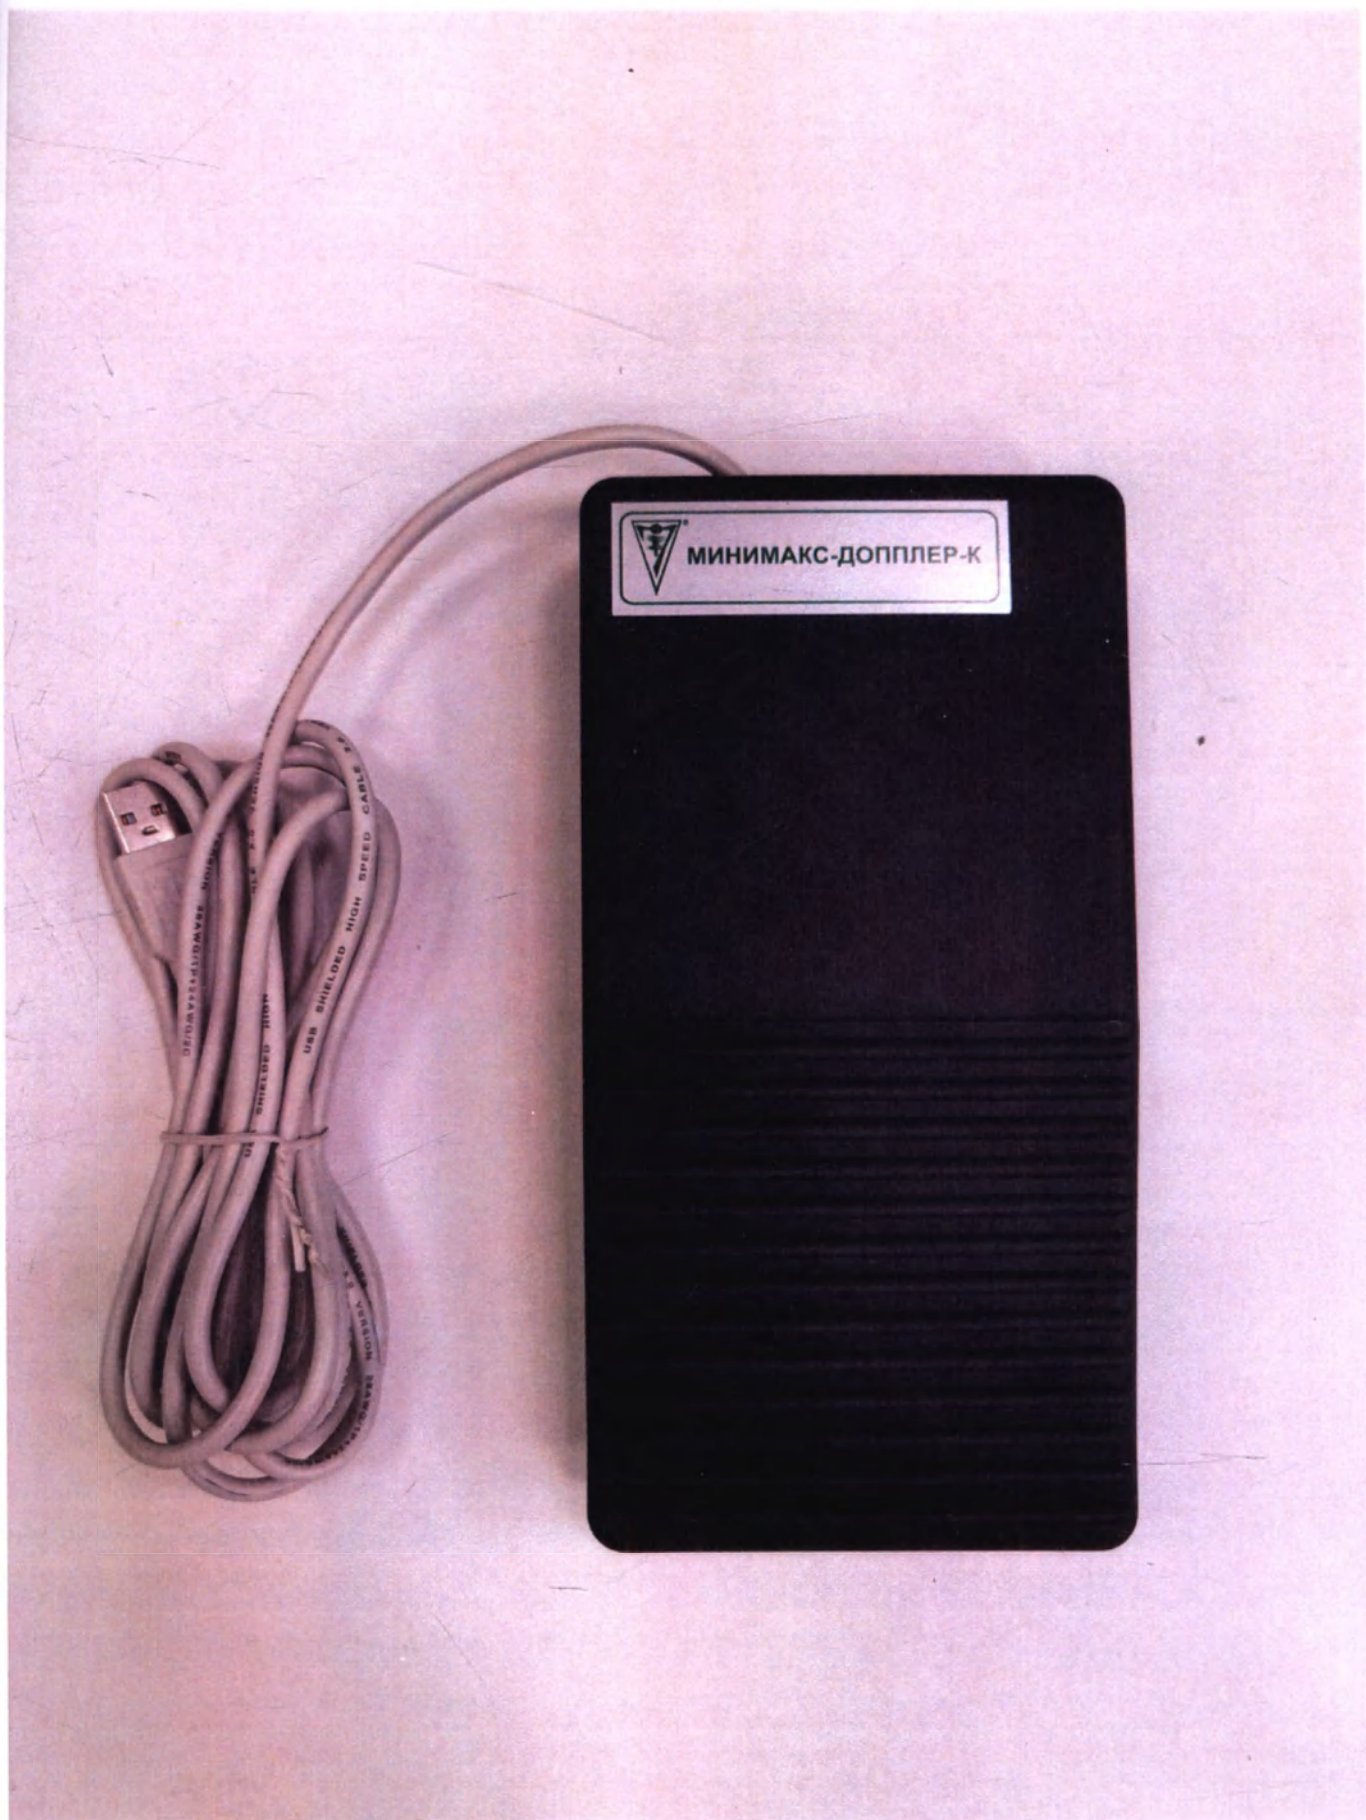


Рисунок 22 – Ножной переключатель (педаль), вид спереди

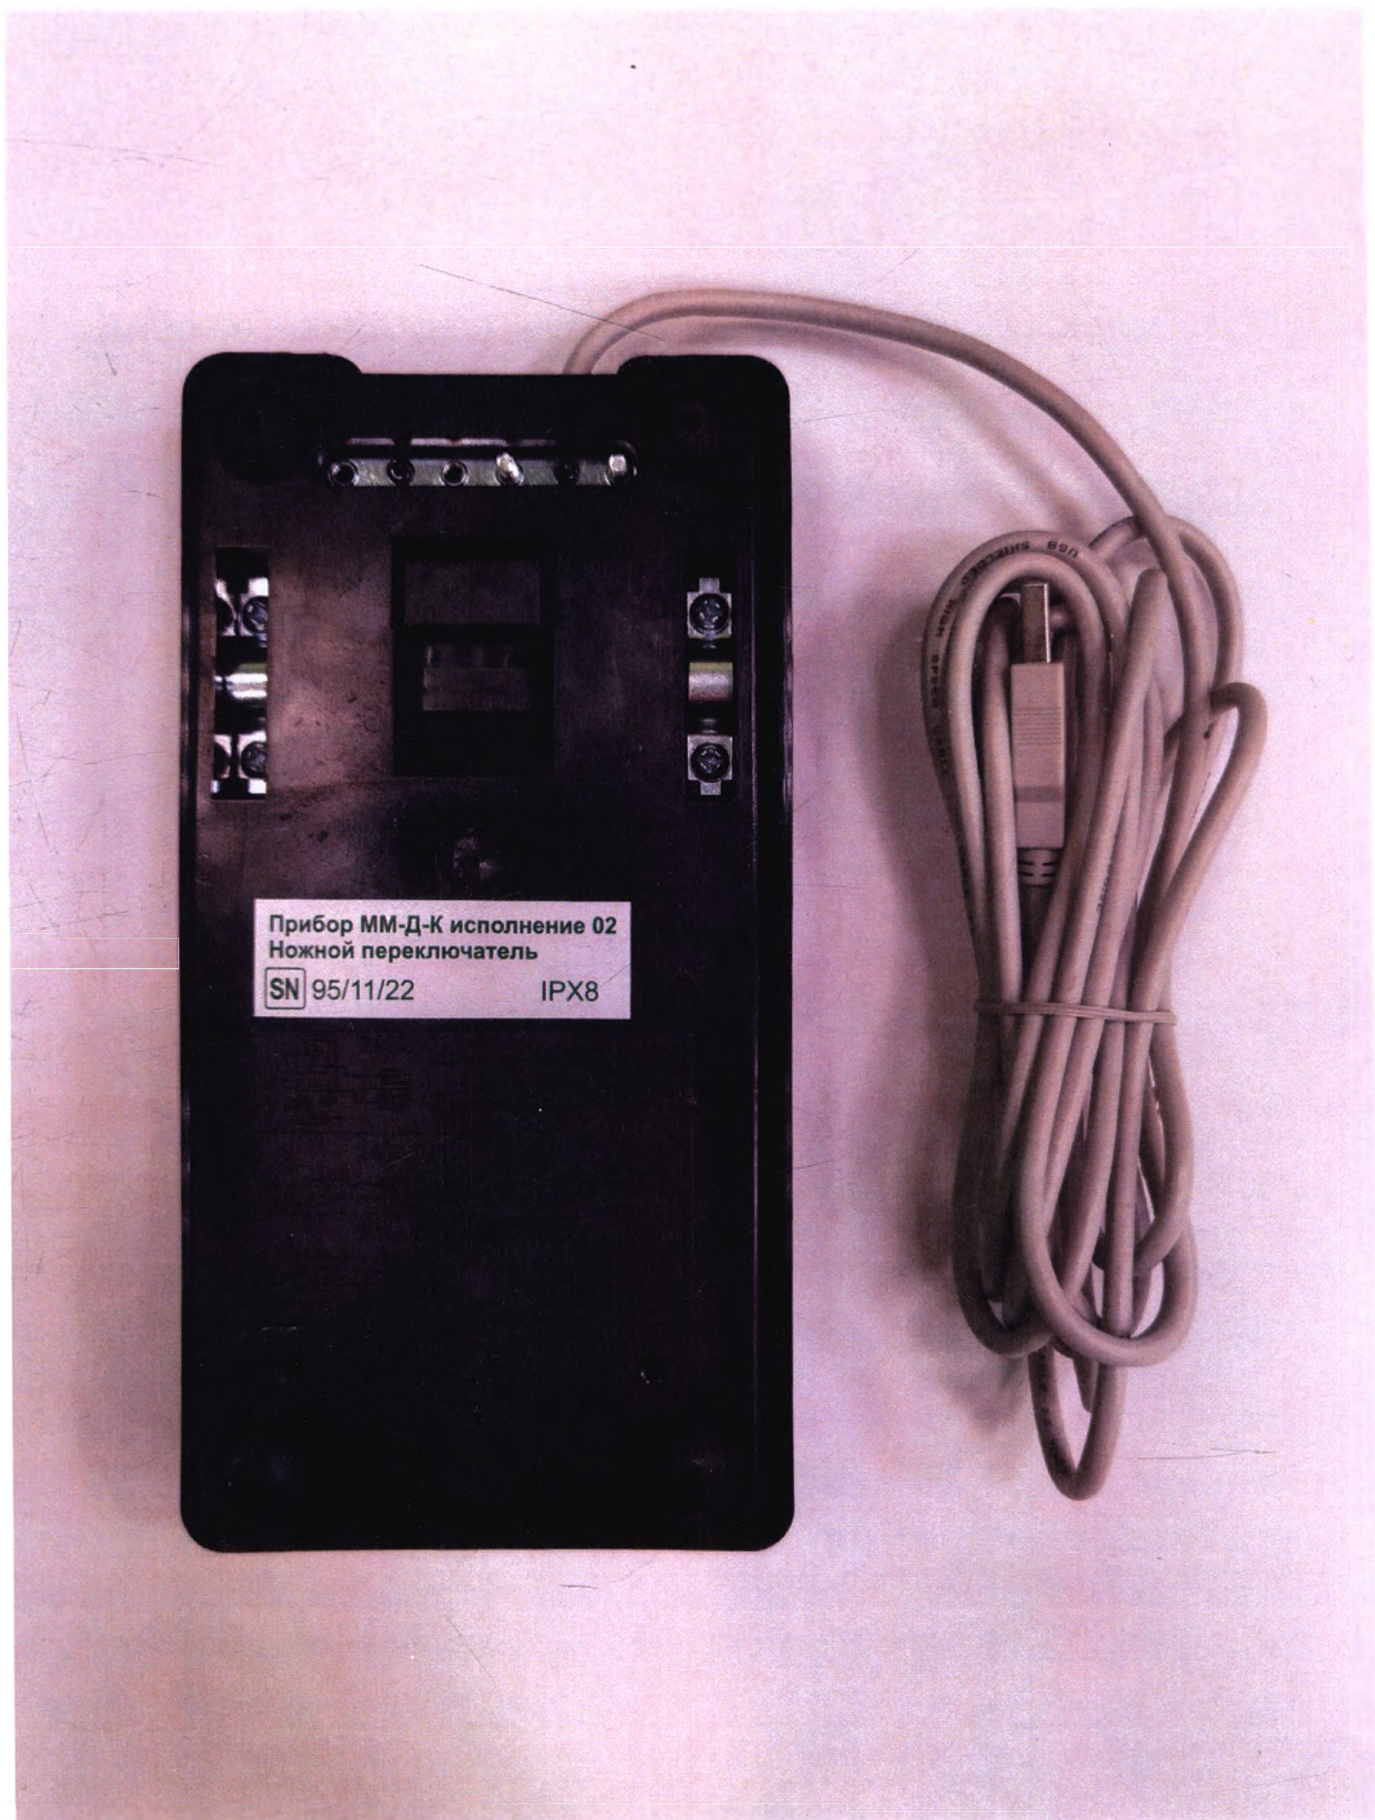


Рисунок 23 – Ножной переключатель (педаль), вид сзади

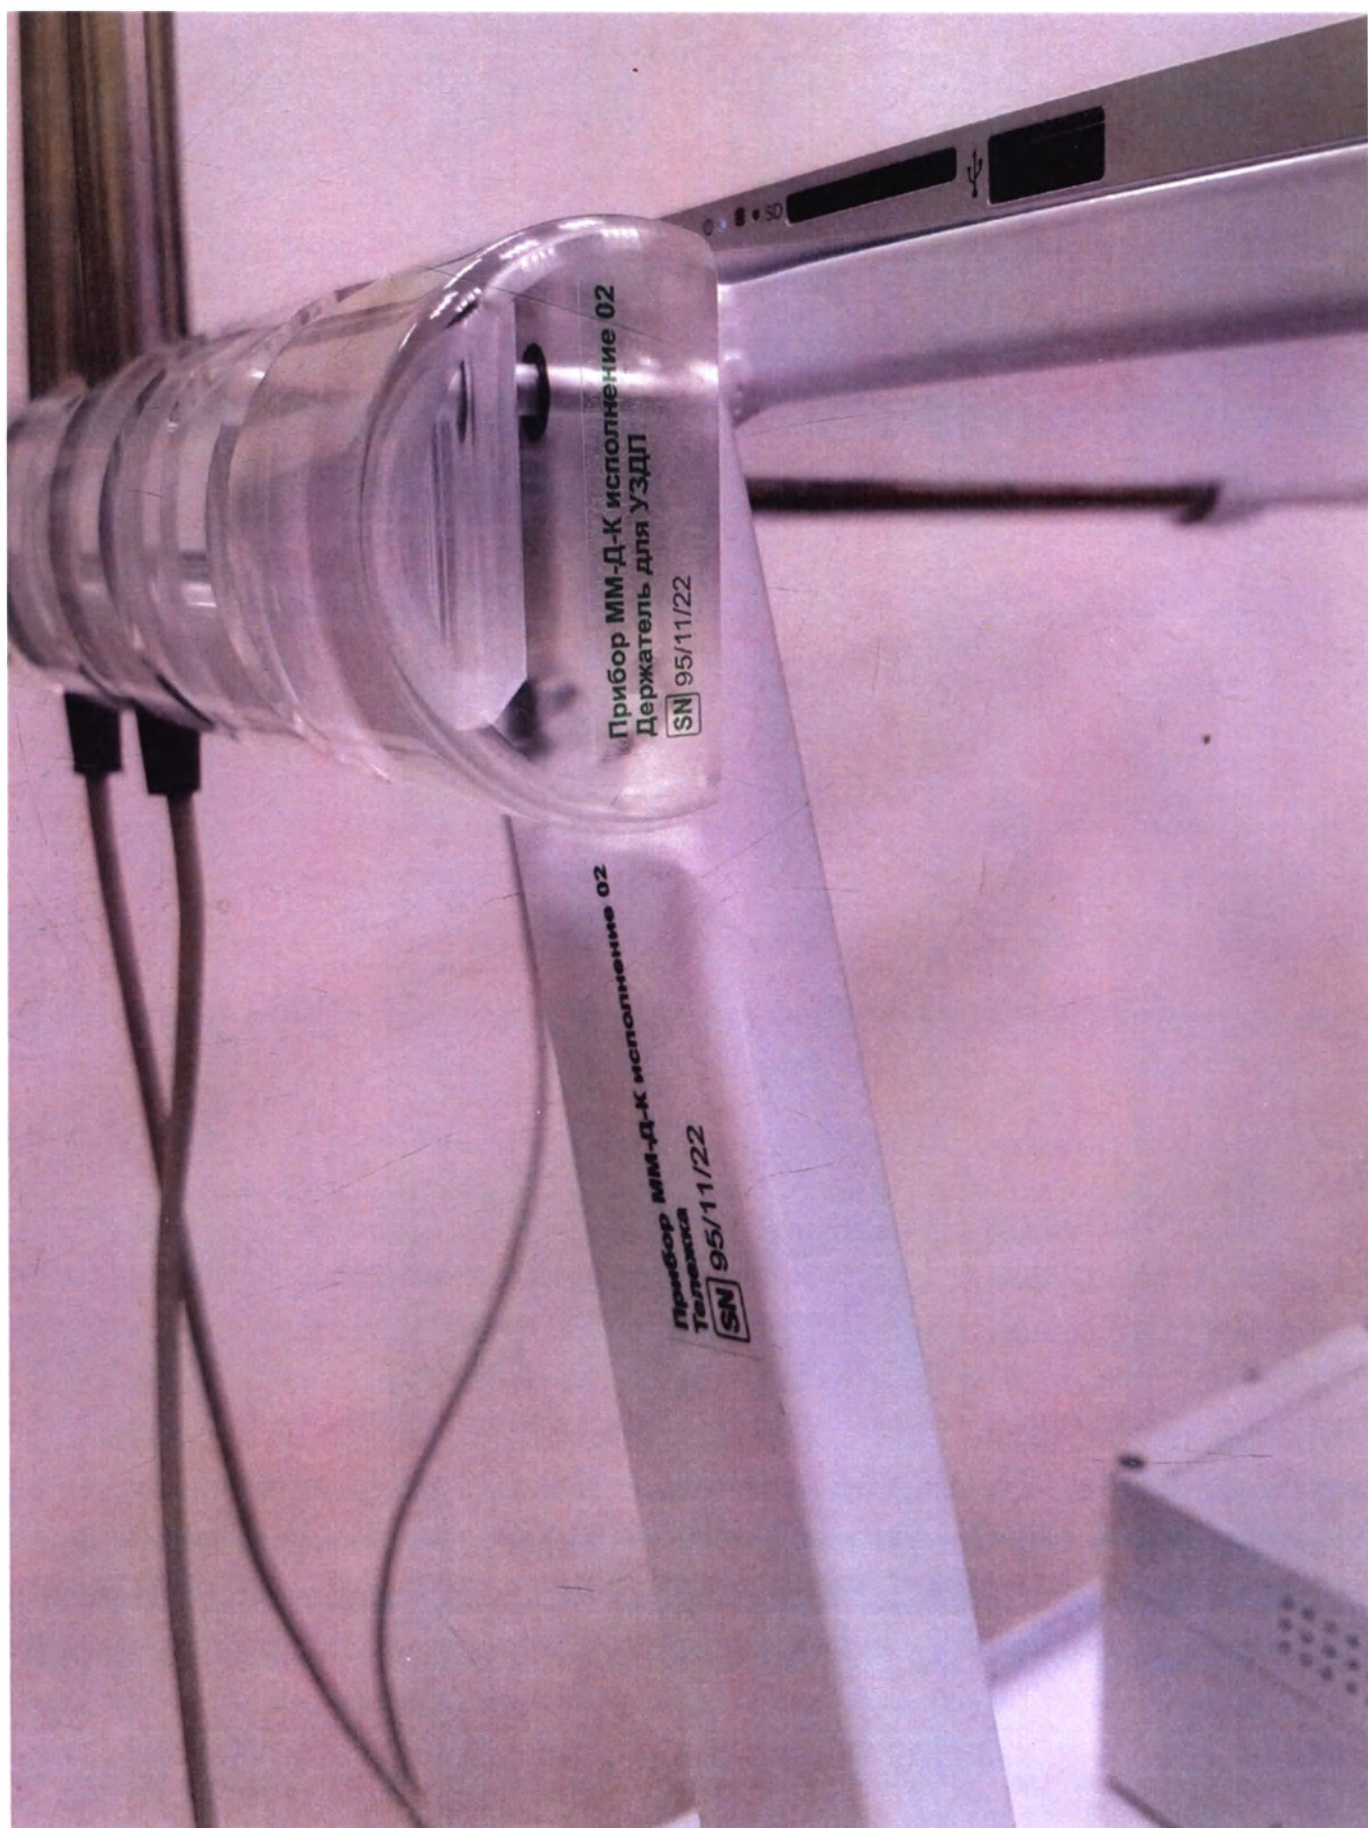


Рисунок 24 – Тележка и держатель для УЗДП, маркировка



Рисунок 25 – Футляр для УЗИП, маркировка



Рисунок 26 – Допплерограф ультразвуковой компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-доплер-К», прибор исполнения 02, транспортная упаковка

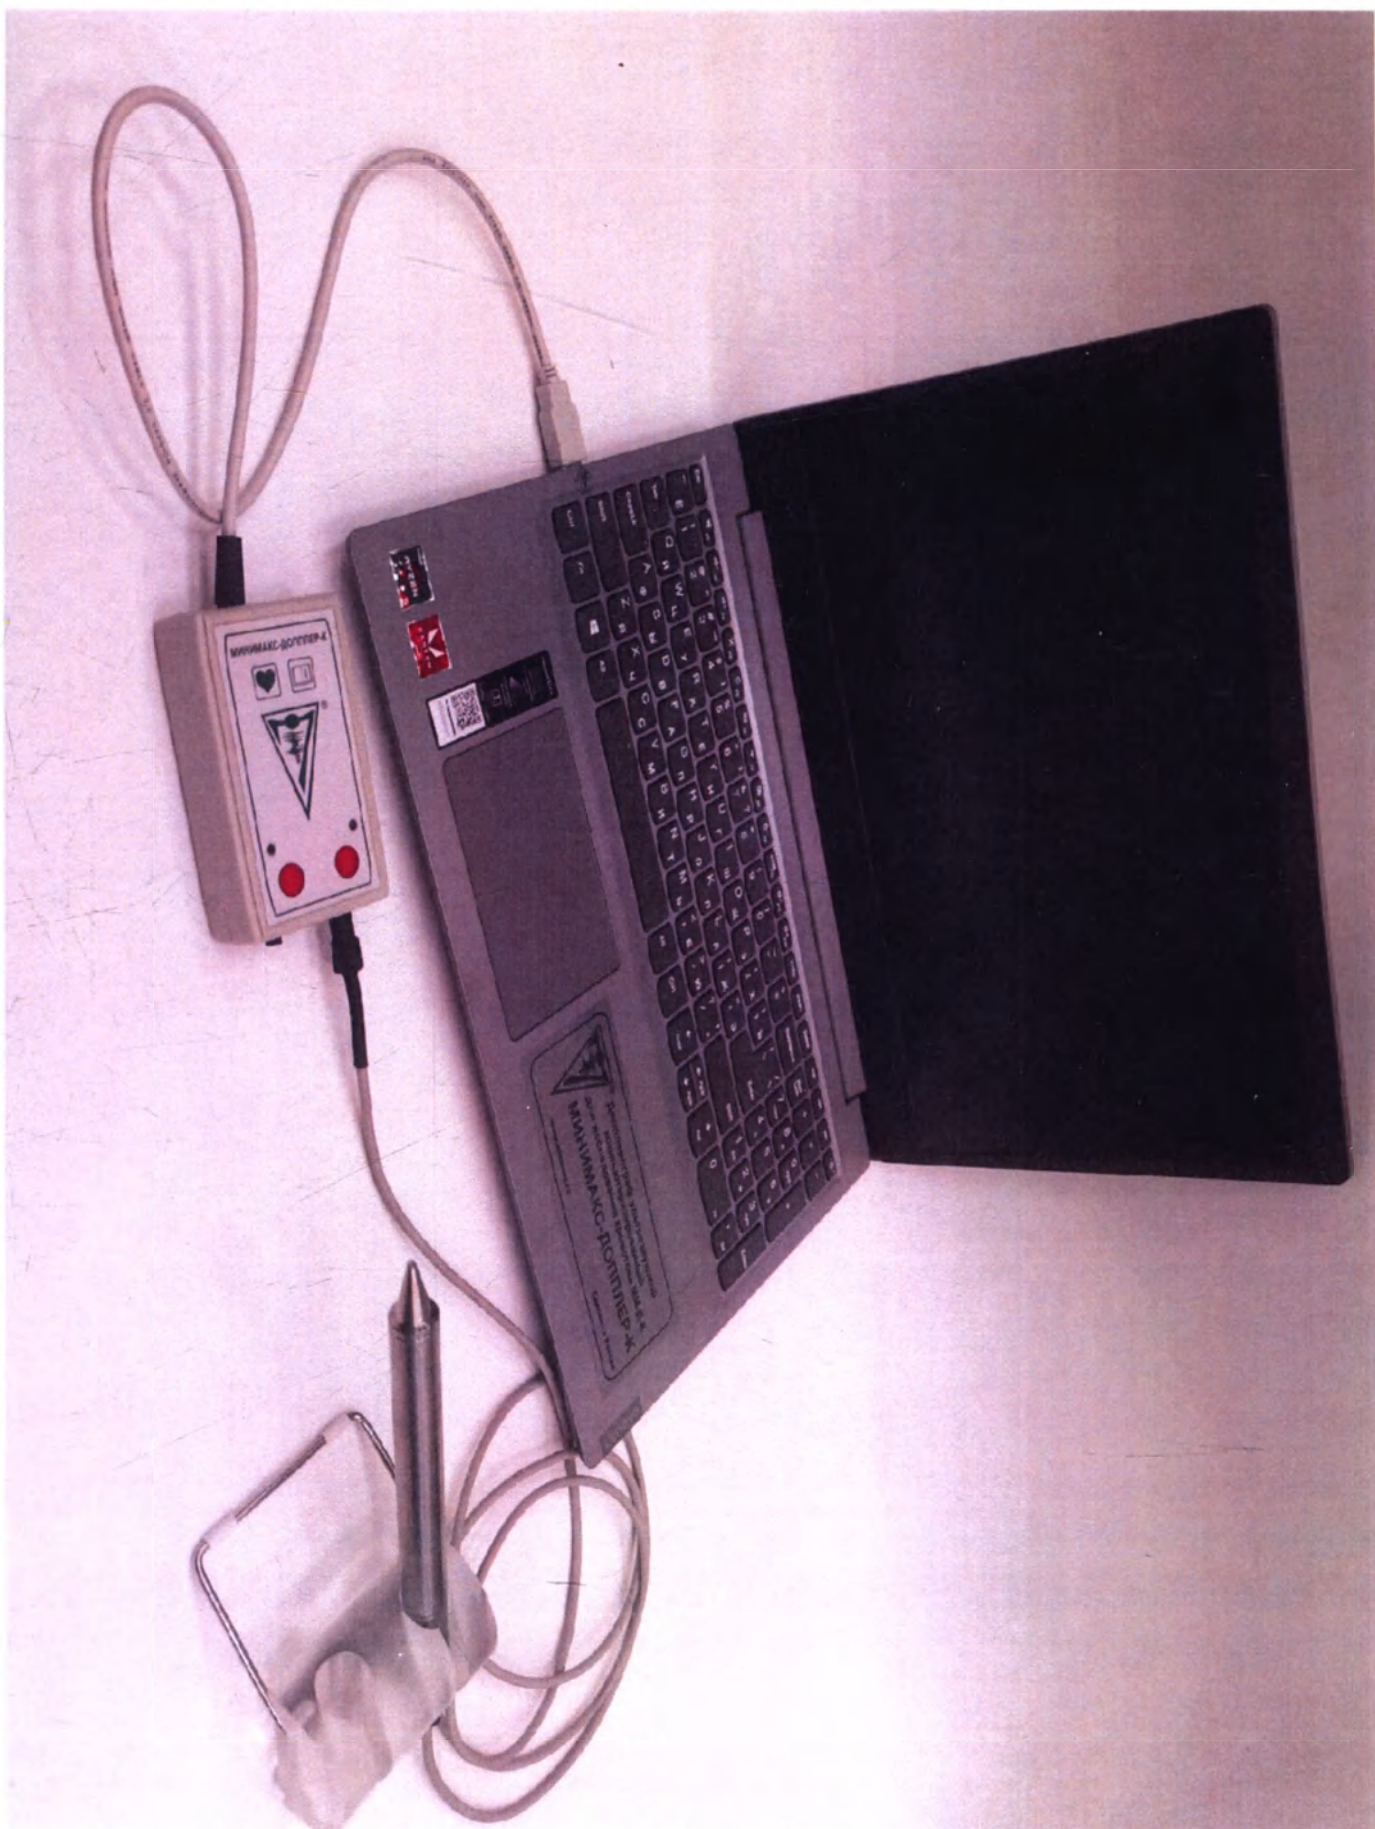


Рисунок 27 – Допплерограф ультразвуковой компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-доплер-К», прибор исполнение 03

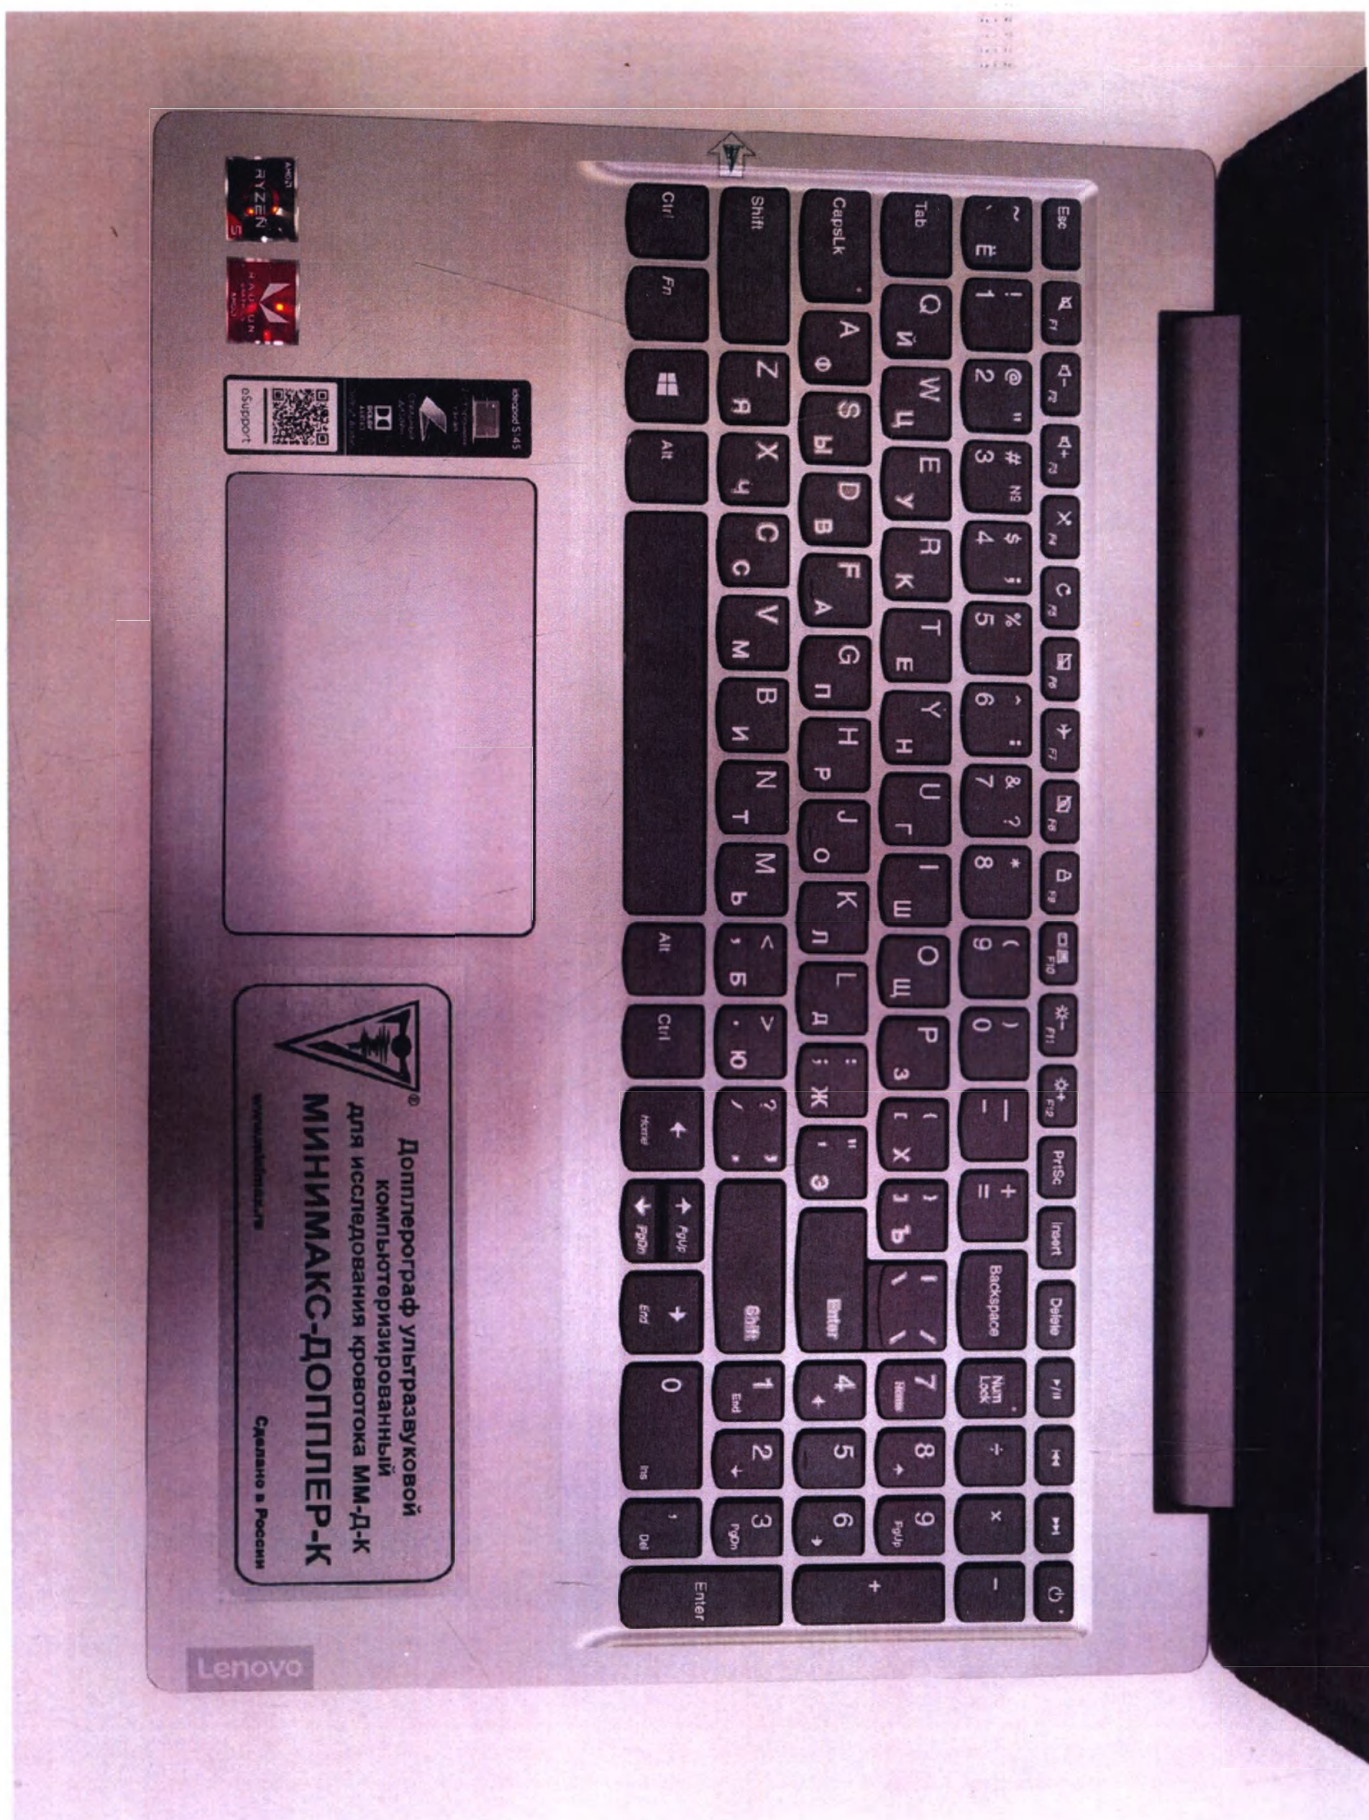


Рисунок 28 – Персональный компьютер в виде ноутбука/нетбука с предустановленным РПО, имеющим источник внутреннего безопасного низкого напряжения, вид спереди

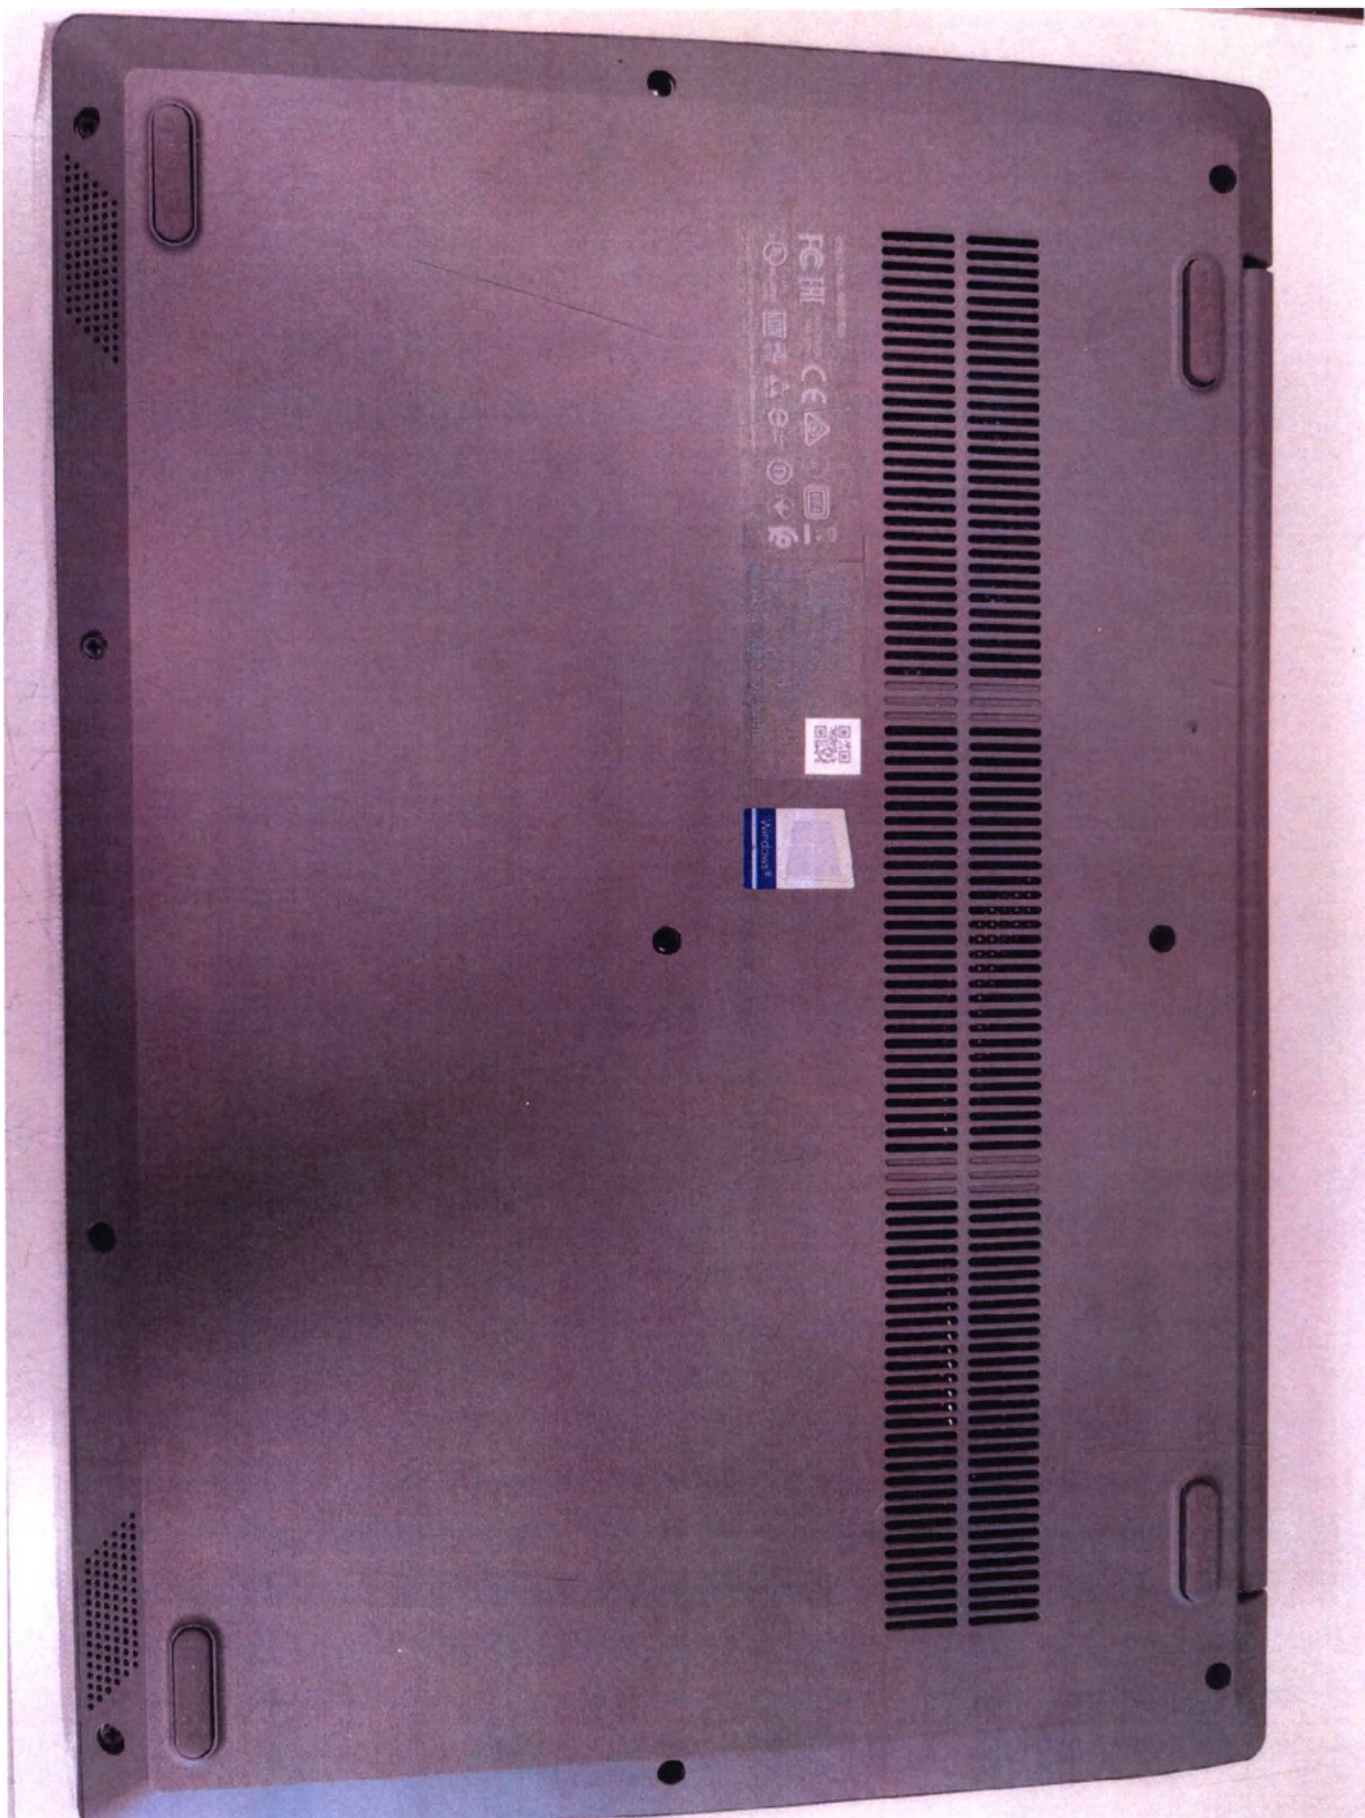


Рисунок 29 – Персональный компьютер в виде ноутбука/нетбука с предустановленным РПО, имеющим источник внутреннего безопасного низкого напряжения, вид сзади

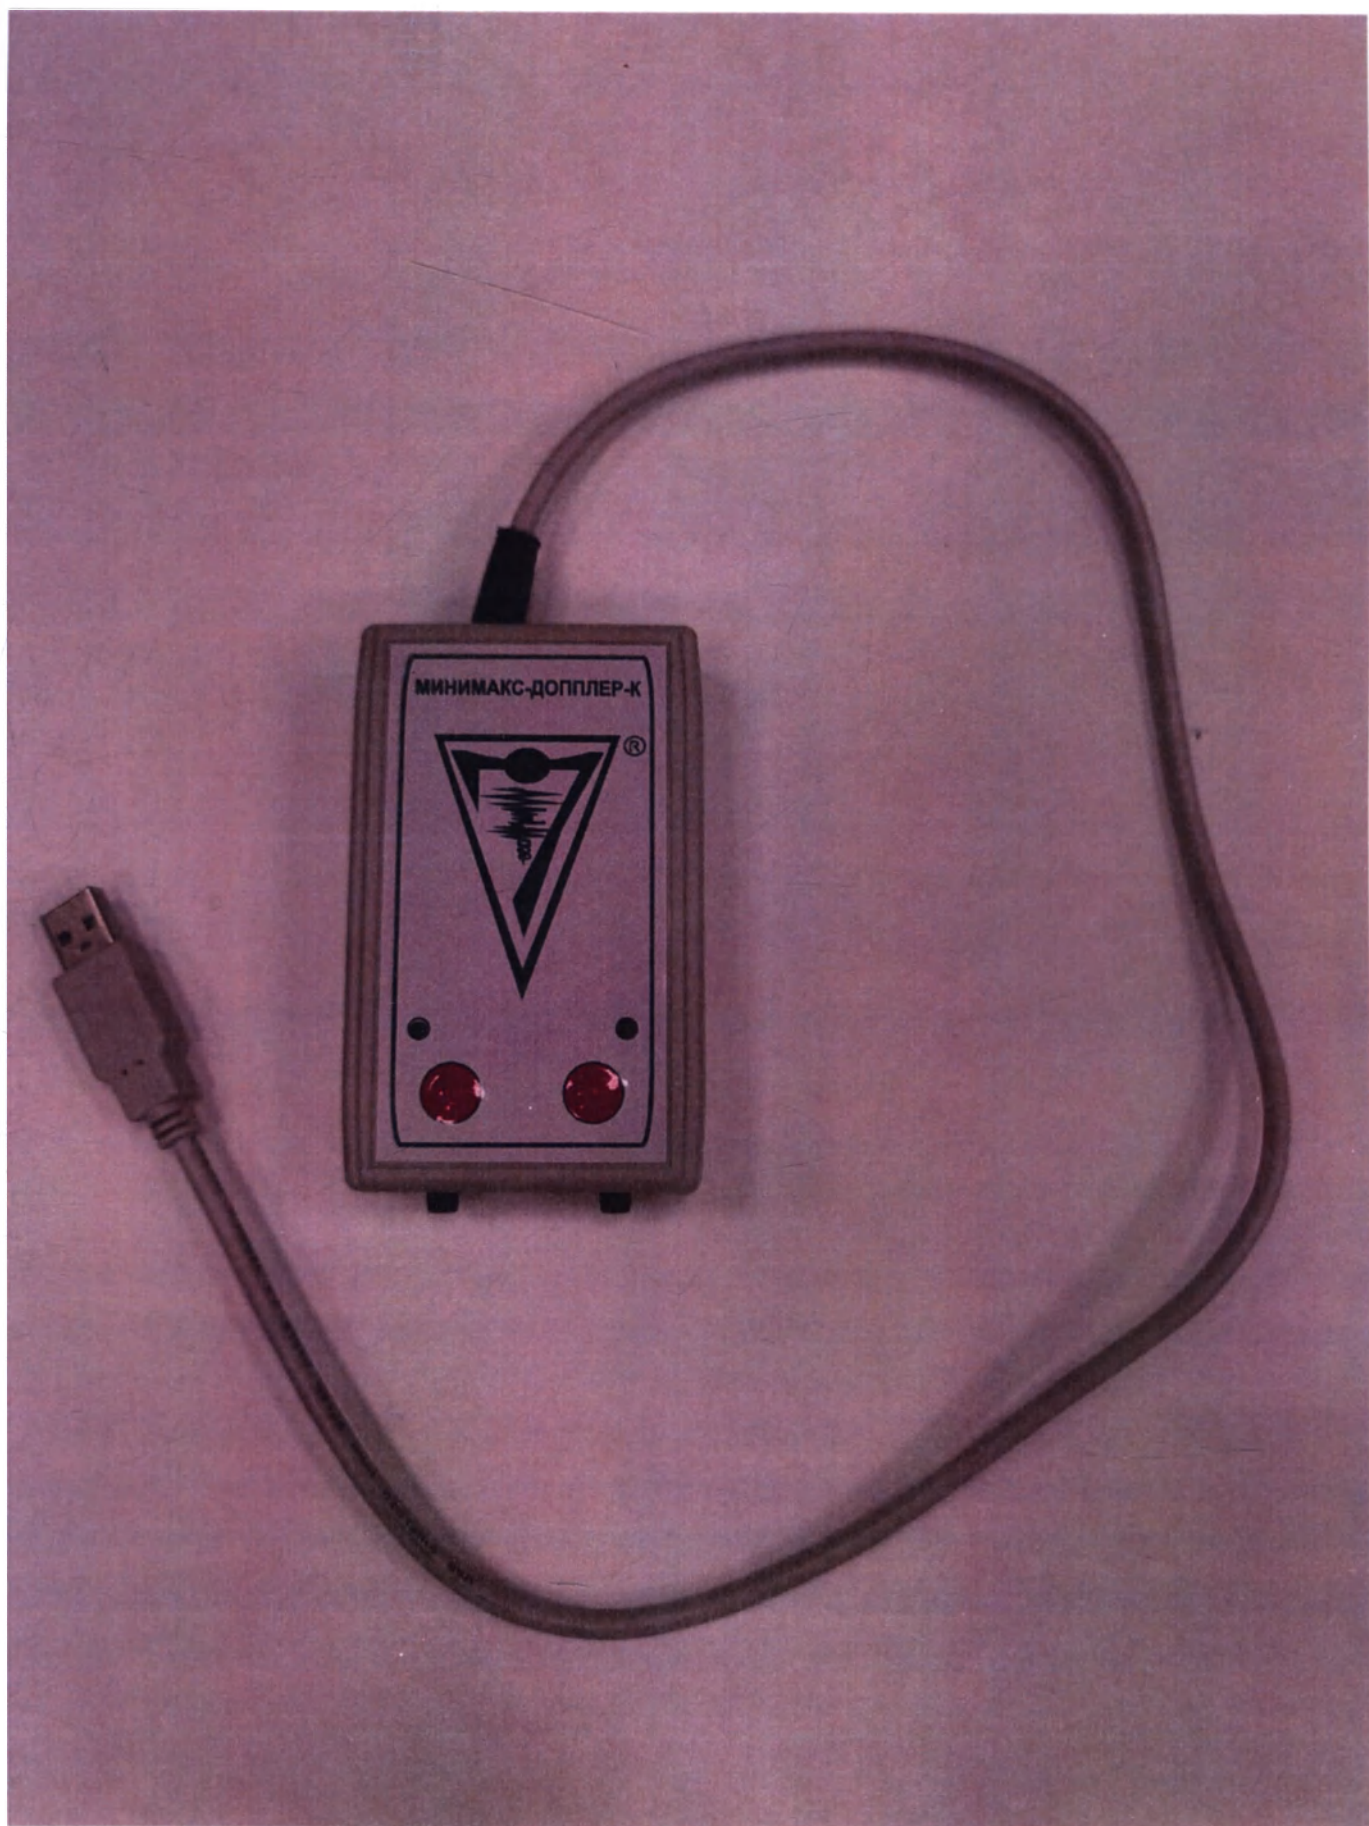


Рисунок 30 – Устройство согласующее, вид спереди



Рисунок 31 – Устройство согласующее, вид сзади



Рисунок 32 – Держатель для УЗДП



Рисунок 33 – Футляр для УЗИДП, маркировка



Рисунок 34 – Допплерограф ультразвуковой компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К «Минимакс-доплер-К», прибор исполнение 03, транспортная упаковка



Рисунок 35 – Ультразвуковые доплеровские преобразователи


ООО «СП Минимакс»

Прошито и пронумеровано

36

листов

Ген. директор



Ахлакова Р.М.

