

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Апексмед Рус»

М.М. Вердиев



2021 г.

Фотографические изображения медицинских изделий

**Набор для введения энтерального питания APEXMED, в
вариантах исполнения.**

Производство:

«Apexmed International B.V.», the Netherlands
(«Апексмед Интернэшнл Б.В.»), Нидерланды

2021 г.

Набор для введения энтерального питания APEXMED, в вариантах исполнения

1. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 500 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и капельной камерой – 1 шт.;
- Коннектор переходной с колпачком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock – 1 шт.;
- Зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. – 1 шт. (при необходимости).

2. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 500 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и капельной камерой – 1 шт.;
- Коннектор переходной с колпачком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором ENFit – 1 шт.;
- Зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором ENFit 60 мл. – 1 шт. (при необходимости).

3. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 500 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и капельной камерой – 1 шт.;
- Коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock – 1 шт.;
- Зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. – 1 шт. (при необходимости).

4. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 500 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и капельной камерой – 1 шт.;
- Коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором ENFit – 1 шт.;
- Зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором ENFit 60 мл. – 1 шт. (при необходимости).

5. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 500 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и капельной камерой – 1 шт.;
- Коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock – 1 шт.;

- Мешок с крышкой объемом 750 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и каплеуловителем – 1 шт.;
- Коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock – 1 шт.;
- Зонд назогастральный CH FR 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости)
- Зонд назогастральный CH FR 12 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости)
- Зонд назогастральный CH FR 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости)
- Зонд назогастральный CH FR 14 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости)
- Зонд назогастральный CH FR 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости)
- Шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. – 1 шт. (при необходимости).

- Шприц с коннектором FNF и 60 мл. – 1 шт. (при необходимости).

* Шприц с коннектором і цег Lock 50 мл. – 1 шт. (при необхідності).

- Шприц с коннектором FNF: 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

- Ширин с коннектором і діаметр 50 мм (за потреби)

Зона истощения (I NFIt (male) = 1 шт. (при необходимости

Зонд назогастральный CИIR 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
Зонд назогастральный CИIR 14 с коннектором F-NFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
Зонд назогастральный CИIR 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
Шприц с коннектором F-NFit 60 мл. – 1 шт. (при необходимости).

16. Набор для введения энтерального питания APREXMED гравитационный с мешком, в составе:

17. Набор для введения энтерального питания API XMI D савитационный с мешком, в составе:

18. Набор для введения эфирного масла API XMFD гравитационный с мешком, в составе:

19. Набор для введения дозированно состоит из 20^4 $\Delta\mu$ (H) градиентный с менком, в составе:

Лубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.:

0. Набор для введения энтерального питания APEAMED гравитационный с мешком, в составе:

1. Набор для введения энтерального питания AcF NMF-D гравитационный с мешком, в составе:

2. Набор для введения интегрального питания APEXMEB гравитационный с мешком, в составе:

23. Набор для введения эндодонтического пиллара API XMI-1 с гравитационный с мешком, в составе:

Вид назоглоточный (с 1 FR 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
Вприс с коннектором (с 1 FR 16, 50 мл – 1 шт. (при необходимости)).

24. Набор для введения энтерального питания API-XMI 12 с грунтоотгонным мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 1000 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и канюлей камерой – 1 шт.;
- Коннектор Luer Lock с переходным коннектором к катетеру – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором FNFit – 1 шт.;
- Зонд назогастральный C11/R 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C11/R 12 с коннектором FNFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C11/R 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C11/R 14 с коннектором FNFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C11/R 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором FNFit 60 мл. (при необходимости).

25. Набор для введения дисперсионного ингалятора Airt-XMI-D гравитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 1200 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и канюлей камерой – 2 шт.;
- Коннектор переходной с кониачком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором Y-Net Lock – 1 шт.;
- Зонд назогастральный C14 R 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C14 R 12 с коннектором F-Net (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C14 R 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C14 R 14 с коннектором F-Net (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C14 R 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором Y-Net Lock 50 мл. – 1 шт. (при необходимости).

26. Набор для введения эндоскопического пиллора АРІХМЕ-ІІ гравитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 1200 мл. – 1 шт.;
- Трубка с вжимом и канюлей диаметром – 1 шт.;
- Коннектор переходной с вжимом – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором LNFit – 1 шт.;
- Зонд назоастральный C16-R 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назоастральный C16-R 12 с коннектором LNFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назоастральный C16-R 4 с стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назоастральный C16-R 4 с коннектором LNFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назоастральный C16-R 10 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шпирц с коннектором LNFit 60 мл. – 1 шт. (при необходимости).

27. Набор для введения плазмидного штамма *Staphylococcus aureus* транзитивный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 120 л м. – 1 шт.;
- Трубка с клапаном и катетером 1000 мм – 1 шт.;
- Коннектор ENFit с периферийным коннектором с лужинками – 1 шт.;
- Двонительный Y-порт – 1 шт. (коннектор Y-Port Lock – 1 шт.);
- Зонд назогастральный 100 R 12 с двойным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный 100 R 12 с коннектором ENFit (smaller) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный 100 R 14 с двойным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный 100 R 14 с коннектором ENFit (smaller) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный 100 R 16 с двойным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шарик с коннектором 100 R 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (при необходимости).

28. Набор для висестной = polypropylene = 4,5-3,475 г/гализированный с менком. В составе:

- Мешок с крапивою (овощ) - 0,01 т/шт.
- Трубка с шлангом (соединитель) - 0,01 т/шт.
- Коннектор USB (соединитель) - 0,01 т/шт.

дополнительный Y порт с коннектором ENET – 1 шт.;

Фонд назогастральный C11/FR 12 со стандартным коннектором — 1 шт. (при необходимости);

Бюнд назогастральный CTE/FR 12 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);

Зонд назогастральный СТИ/Р 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);

Зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) 1 шт. (при необходимости);

Зонд назогастральный С 11/гК 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);

Шприц с коннектором I-NT-11 (60 мл, -- 1 шт. (при необходимости).

29. Набор для введения энтерального питания АгЕХМФ-Д гравитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 1200 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и каплепадной камерой – 1 шт.;
- Коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock – 1 шт.;
- Зонд назогастральный C11R 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C11R 12 с коннектором INFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C11R 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C11R 14 с коннектором INFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный C11R 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. – 1 шт. (при необходимости).

30. Набор для введения интратрахеального аппарата APFEXMF-D (гравитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 1200 мл. – 1 шт.;
- Трубка с зажимом и канюлей камерой – 1 шт.;
- Коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором ENFit – 1 шт.;
- Зонд назогастральный CMFR 12 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CMFR 12 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CMFR 14 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CMFR 14 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный CMFR 16 со стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором ENFit 60 мл. – 1 шт. (при необходимости).

31. Набор для введения перитонеального питания APENMED транзитационный с мешком, в составе:

- Мешок с крышкой объемом 1500 мл. – 1 шт.;
- Грубка с зажимом и капиллярной камерой – 1 шт.;
- Коннектор переходной с хвостиком – 1 шт.;
- Дополнительный Y порт с коннектором 1 set Lock – 1 шт.;
- Зонд назогастрастный 11 Fx 12 с стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастрастный 11 Fx 12 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастрастный 11 Fx 14 с стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастрастный 11 Fx 14 с коннектором ENFit (female) – 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастрастный 11 Fx 16 с стандартным коннектором – 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором 1 set Lock, 30 мл. – 1 шт. (при необходимости).

32. Набор для введения интерактивного питания APTXMF с гравитационный с мешком, в составе:


- Мешок с крышкой объемом 500 мл. — 1 шт.
- Трубка с зажимом и канюлей диаметром 1,5 мм.
- Коннектор переходной с канюлькой — 1 шт.
- Дополнительный Y шприц с канюлькой №10 и №12.
- Зонд назогастральный (50 см, 1,5 мм с канюлей) с коннектором — 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный (50 см, 1,5 мм с канюлей) с Y-образным соединителем — 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный (50 см, 1,5 мм с канюлей) с Y-образным соединителем — 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный (50 см, 1,5 мм с канюлей) с Y-образным соединителем — 1 шт. (при необходимости);
- Зонд назогастральный (50 см, 1,5 мм с канюлей) с Y-образным соединителем — 1 шт. (при необходимости);
- Шприц с коннектором №10 и №12 — 1 шт. (при необходимости).

Фотографическое изображение общего вида набора для введения энтерального питания APEXMED гравитационного с мешком.




Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком
(вариант исполнения №19)

Фотографическое изображение общего вида набора для введения энтерального питания APEXMED гравитационного с контейнером.

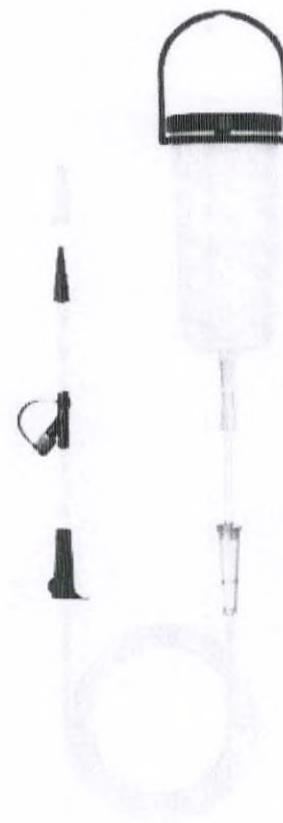


Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с контейнером
(вариант исполнения № 41)

Фотографическое изображение объектов из набора для введения интерального питания
APL XME D (вариант исполнения без мешка и контейнера)



Набор для введения интерального питания APL XME D стационарный без мешка и
контейнера (вариант исполнения № 43)


Фотографическое изображение объектов из набора для введения интерального питания
APL XME D с помощью насоса с мешком

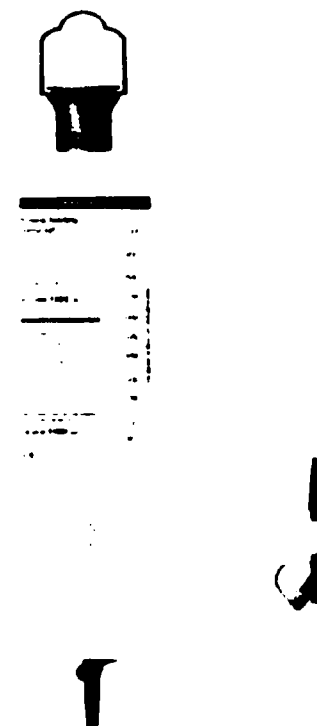

Набор для введения интерального питания APL XME D с помощью насоса с мешком
(вариант исполнения № 67)

Фотографические изображения составных частей, входящих в наборы для введения
интравенного питания АРЕНМТО

1. Мешок с крышкой

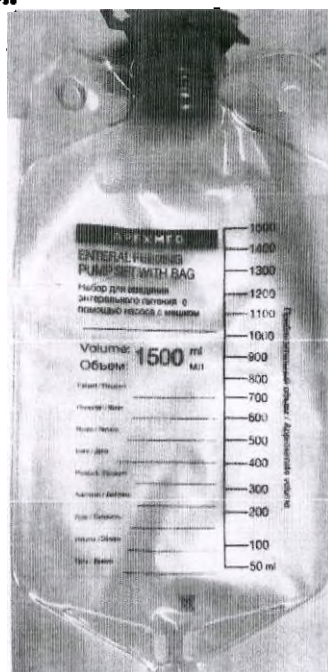


Мешок с крышкой, объем 1500 мл.

2. Контейнер с крышкой




Контейнер с крышкой, объем 600 мл.

3. Трубка с зажимом и капельной камерой

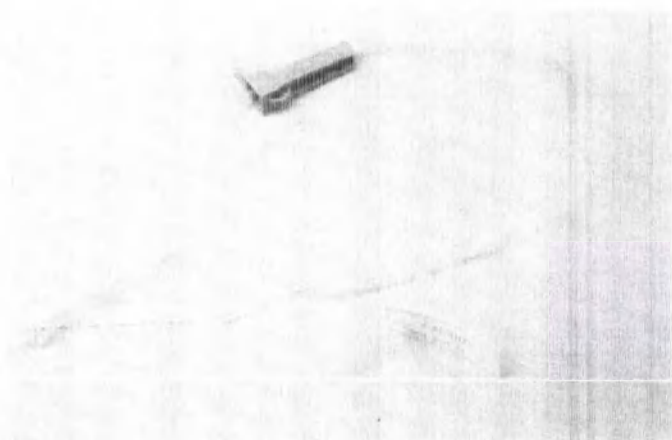


Трубка с зажимом и капельной камерой

4. Устройство для прокалывания крышки контейнера с питательной смесью с колпачком.

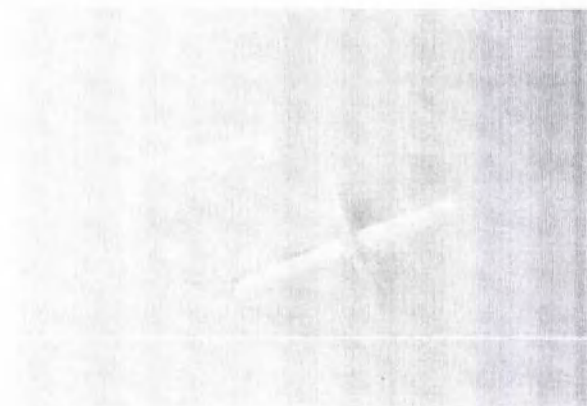


Устройство для прокалывания крышки контейнера с питательной смесью с колпачком

5. Коннектор переходной с колпачком

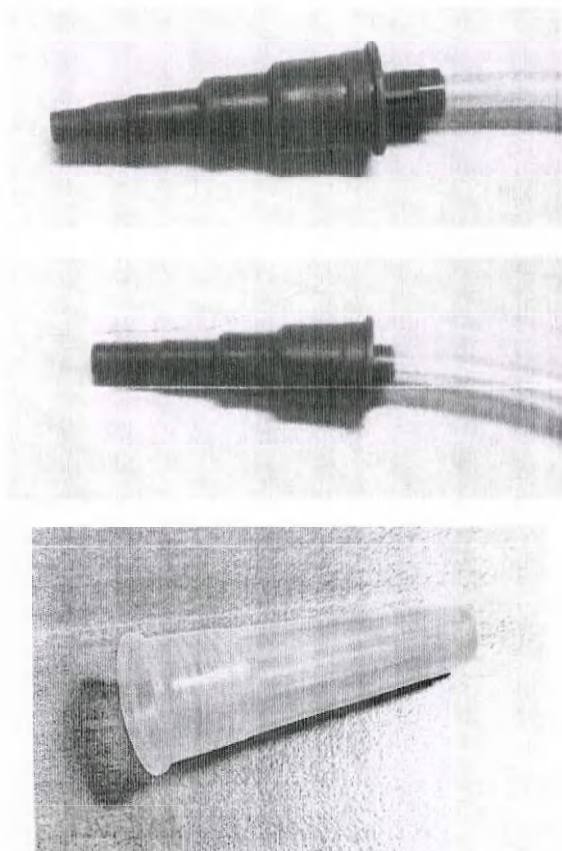

Коннектор переходной с колпачком (в двух исполнениях, по согласованию с заказчиком)

6. Коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком

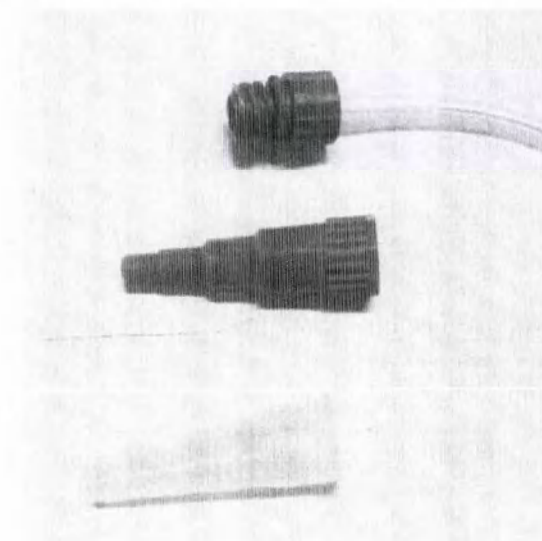

Коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком

7. Коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком




Коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком

8. Дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock




Дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock

9. Дополнительный Y порт с коннектором ENFit.



Дополнительный Y порт с коннектором ENFit

10. Зонд назогастраальный со стандартным коннектором.

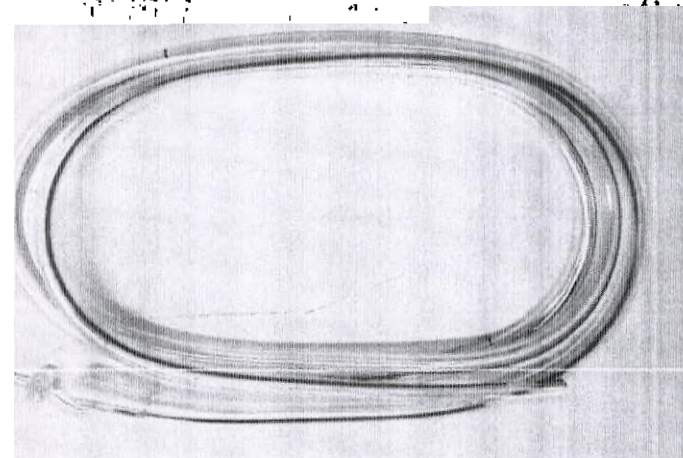

Зонд назогастраальный, размер CH/FR 16 со стандартным коннектором

11. Зонд назогастральный с коннектором ENFit.

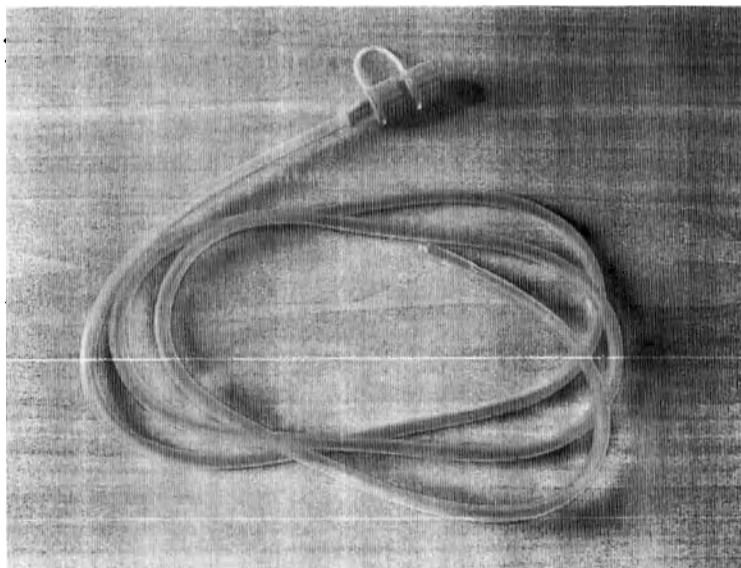



Рис. 11. Зонд назогастральный с коннектором ENFit

12. Шприц с коннектором Luer Lock




Рис. 12. Шприц с коннектором Luer Lock


13. Шприц с коннектором ENFit

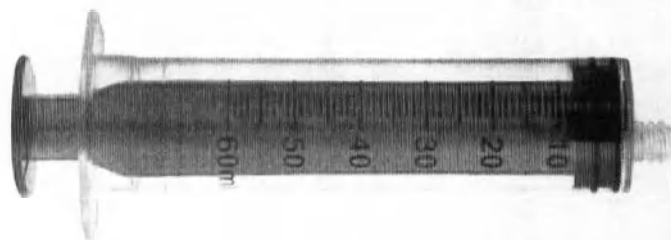


Шприц с коннектором ENFit 60 мл.

Фотографическое изображение упаковки набора для введения энтерального питания
APREXMED гравитационный с мешком.

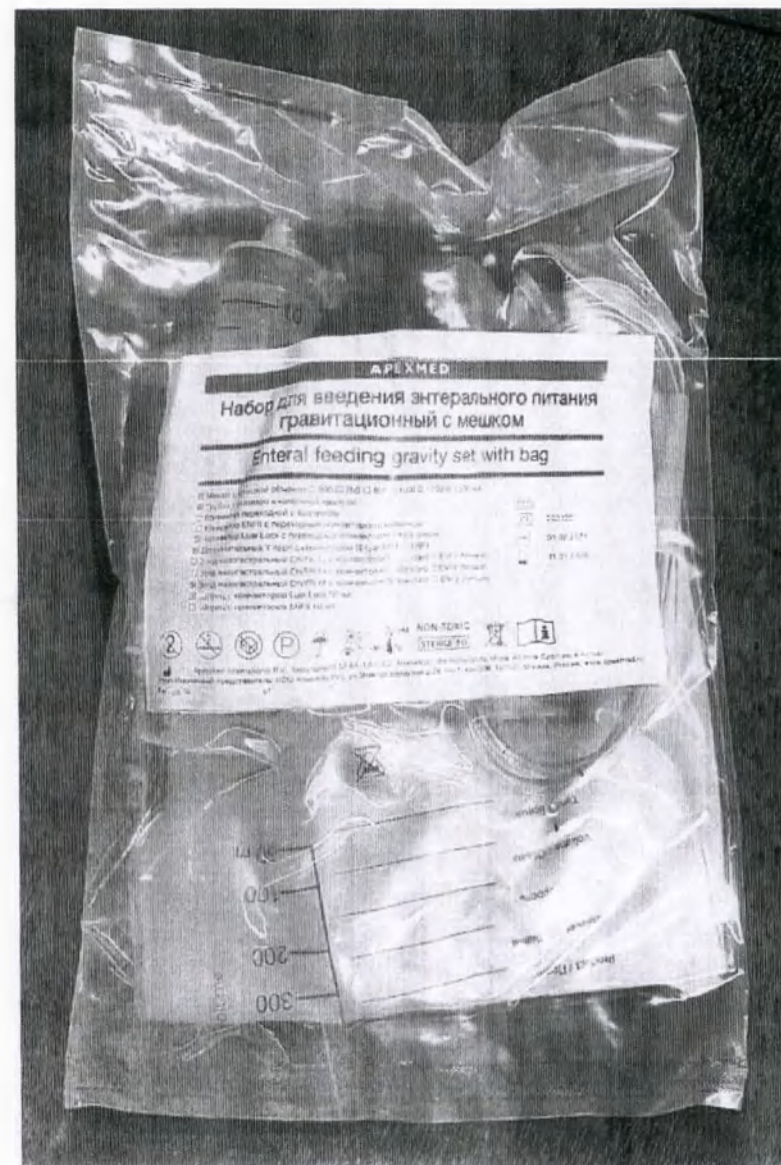

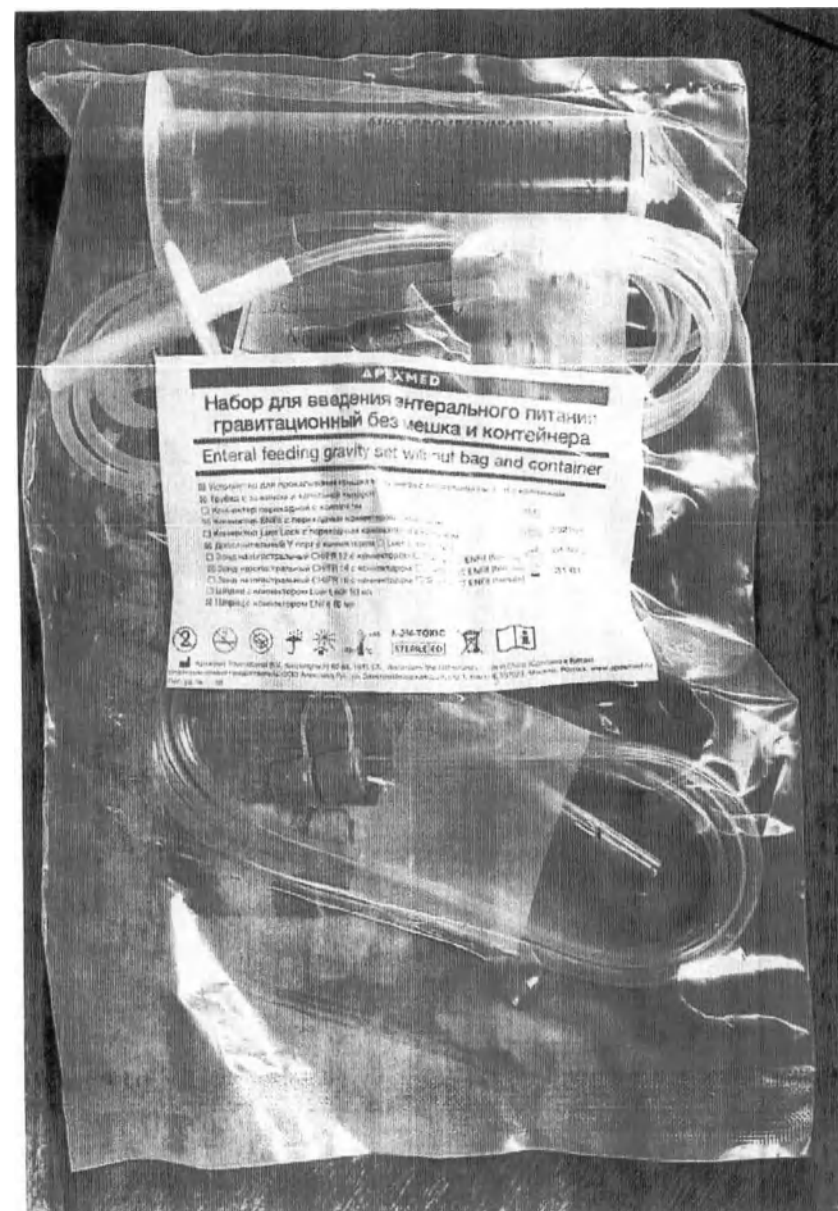

Фототриггер, в комплекте с насосом для введения энтерального питания
 APEXMED

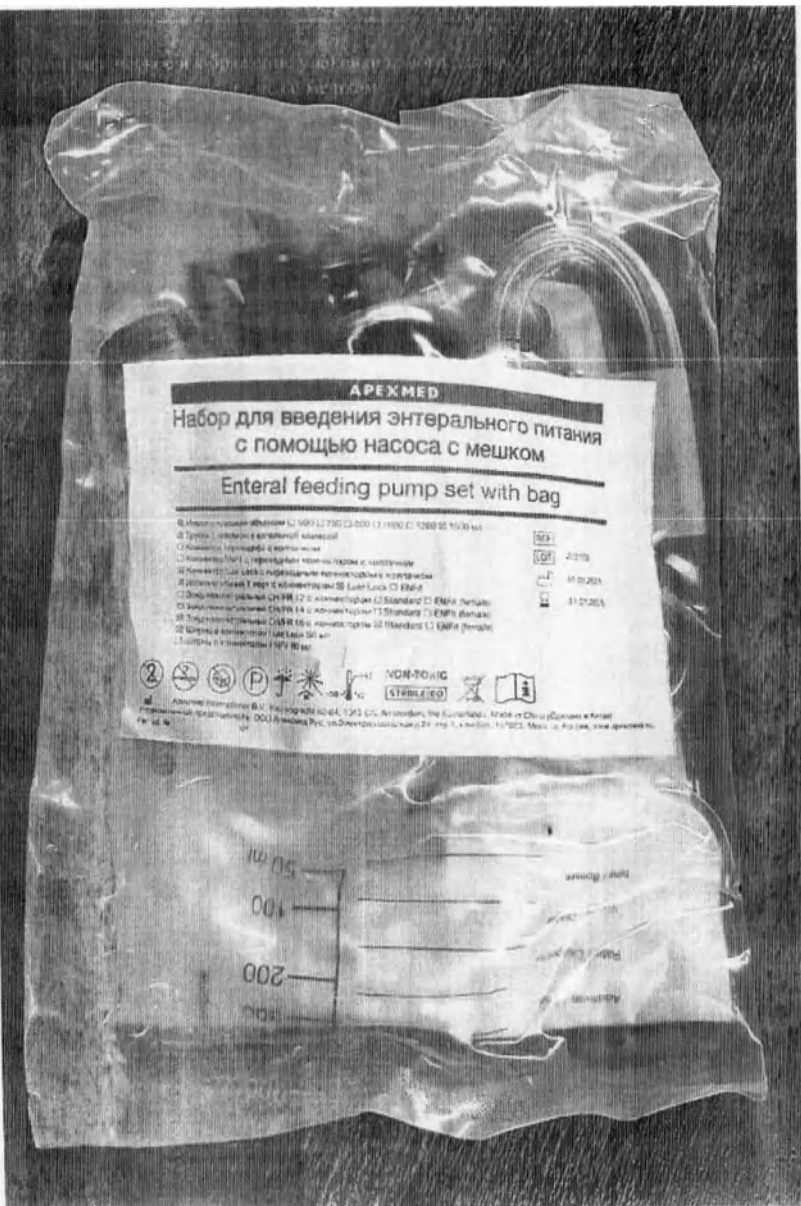

Счито и заверено печатью
 (1.01.0000) ГИСТ

Генеральный директор
 ООО "Апексмед Рус"
 М.М.Вардица

