

## Фотографические изображения изделий

«Аспиратор медицинский электрический, зарегистрированный товарный знак MED-MOS»

I. Аспиратор медицинский электрический H001, H002 в составе:

1. Аспиратор медицинский электрический
2. Мягкая аспирационная трубка – 1 шт. (при необходимости)
3. Трубчатый плавкий предохранитель – 2 шт. (при необходимости)
4. Кабель питания – 1 шт. (при необходимости)
5. Педальный выключатель – 1 шт. (при необходимости)
6. Воздушный фильтр – 2 шт. (при необходимости)
7. Руководство по эксплуатации -- 1 шт.

II. Аспиратор медицинский электрический портативный H003-A, H003-B, H003-C, H003-D, H003-E, H003-F, в составе:

1. Аспиратор медицинский электрический портативный
2. Мягкая аспирационная трубка – 1 шт. (при необходимости)
3. Воздушный фильтр – 2 шт. (при необходимости)
4. Трубчатый плавкий предохранитель – 2 шт. (при необходимости)
5. Кабель питания – 1 шт. (при необходимости)
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Управляющий-Индивидуальный предприниматель ООО «Медтехника-Р»



/Сирин И. В.

Аспиратор медицинский электрический,  
зарегистрированный товарный знак MED-MOS  
Модель H001

Энергоснабжение:  $230V \pm 10\% \sim 50\text{Гц}$

Входная мощность:  $\leq 150VA \pm 15\%$

Атмосферное давление:  $86\text{кПа} - 106\text{кПа}$

Низкий вакуум/средний расход




Jiangsu Folee Medical Equipment Co., Ltd.  
No. 16 Xingmao Road, 212009, Zhenjiang  
City, Jiangsu, People's Republic of China


Классификация продукции: Класс IIa

Электрическая классификация: тип I, класс B


Регистрационное удостоверение № PЗН 2020/9574 от «09» сентября 2020 г.



NR863208-010



07/2021





Аспиратор медицинский электрический,  
зарегистрированный товарный знак MED-MOS  
Модель H002



Энергоснабжение:  $230V \pm 10\% \sim 50\text{Гц}$   
Входная мощность:  $\leq 150\text{ВА} \pm 15\%$   
Атмосферное давление:  $86\text{кПа} - 106\text{кПа}$   
Низкий вакуум/средний расход




**Jiangsu Folee Medical Equipment Co., Ltd.**  
No. 16 Xingmao Road, 212009, Zhenjiang  
City, Jiangsu, People's Republic of China




Классификация продукции: Класс IIa

Электрическая классификация: тип I, класс B

Регистрационное удостоверение № P3H 2020/9574 от «09» сентября 2020 г.



NR423764-018



07/2021



Уполномоченный представитель на территории России: Общество с  
ограниченной ответственностью «Медтехника Реботек», 125222, г. Москва, ул.  
Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещение X, тел. +7 (495) 504-26-51



Аспиратор медицинский электрический  
портативный, зарегистрированный товарный знак  
MED-MOS



Модель H003-A

Энергоснабжение: 230В±10% ~50Гц±10%; 12,6В

Входная мощность: ≤90ВА±10%

Макс. отрицательное давление (макс. вакуум): ≥0,075 МПа

Диапазон регулирования давления (диапазон вакуума): 0,02–0,075 МПа

Низкий вакуум/средний расход



Jiangsu Folee Medical Equipment Co., Ltd.

No. 16 Xingmao Road, 212009, Zhenjiang City,

Jiangsu, People's Republic of China




Классификация продукции: Класс IIa

Электрическая классификация: тип I, класс B



Регистрационное удостоверение № 2020/9574 от «30» января 2020 года



GE826410-112



07/2021



Уполномоченный представитель на территории России: Общество с  
ограниченной ответственностью «Медтехника Реботек», 125222, г. Москва, ул.  
Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещение X, тел. +7 (495) 504-26-51



Аспиратор медицинский электрический  
портативный, зарегистрированный товарный знак  
MED-MOS



Модель H003-B

Энергоснабжение:  $230V \pm 10\% \sim 50\text{Гц} \pm 10\%$

Входная мощность:  $\leq 90\text{ВА} \pm 10\%$

Макс. отрицательное давление (макс. вакуум):  $\geq 0,070 \text{ МПа}$

Диапазон регулирования давления (диапазон вакуума):  $0,02 - 0,070 \text{ МПа}$

Низкий вакуум/средний расход



Jiangsu Folee Medical Equipment Co., Ltd.  
No. 16 Xingmao Road, 212009, Zhenjiang City,  
Jiangsu, People's Republic of China



Классификация продукции: Класс Па


Электрическая классификация: тип I, класс B



Регистрационное удостоверение № 2020/9574 от «30» января 2020 года



GE274930-012



07/2021



Уполномоченный представитель на территории России: Общество с  
ограниченной ответственностью «Медтехника Реботек», 125222, г. Москва, ул.  
Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещение X, тел. +7 (495) 504-26-51



Аспиратор медицинский электрический  
портативный, зарегистрированный товарный знак  
MED-MOS



Модель H003-C

Энергоснабжение:  $230V \pm 10\% \sim 50\text{Гц} \pm 10\%$

Входная мощность:  $\leq 90\text{ВА} \pm 10\%$


Макс. отрицательное давление (макс. вакуум):  $\geq 0,075\text{ МПа}$

Диапазон регулирования давления (диапазон вакуума):  $0,02-0,075\text{ МПа}$

Низкий вакуум/средний расход



**Jiangsu Folee Medical Equipment Co., Ltd.**  
No. 16 Xingmao Road, 212009, Zhenjiang City,  
Jiangsu, People's Republic of China



Классификация продукции: Класс IIa

Электрическая классификация: тип I, класс B



Регистрационное удостоверение № 2020/9574 от «30» января 2020 года



FE003728-022



07/2021



Уполномоченный представитель на территории России: Общество с  
ограниченной ответственностью «Медтехника Реботек», 125222, г. Москва, ул.  
Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещение X, тел. +7 (495) 504-26-51



Аспиратор медицинский электрический  
портативный, зарегистрированный товарный знак  
MED-MOS



Модель H003-D

Энергоснабжение:  $230V \pm 10\% \sim 50\text{Гц} \pm 10\%$

Входная мощность:  $\leq 90\text{ВА} \pm 10\%$

Макс. отрицательное давление (макс. вакуум):  $\geq 0,070\text{ МПа}$

Диапазон регулирования давления (диапазон вакуума):  $0,02-0,070\text{ МПа}$

Низкий вакуум/средний расход



Jiangsu Folee Medical Equipment Co., Ltd.

No. 16 Xingmao Road, 212009, Zhenjiang City,

Jiangsu, People's Republic of China



Классификация продукции: Класс IIa

Электрическая классификация: тип I, класс B



Регистрационное удостоверение № 2020/9574 от «30» января 2020 года



KJ384290-010



07/2021



Уполномоченный представитель на территории России: Общество с  
ограниченной ответственностью «Медтехника Реботек», 125222, г. Москва, ул.  
Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещение X, тел. +7 (495) 504-26-51



Аспиратор медицинский электрический  
портативный, зарегистрированный товарный знак  
**MED-MOS**



Модель H003-E

Энергоснабжение:  $230V \pm 10\%$  ~  $50\text{Гц} \pm 10\%$

Входная мощность:  $\leq 90\text{ВА} \pm 10\%$

Макс. отрицательное давление (макс. вакуум):  $\geq 0,070\text{ МПа}$

Диапазон регулирования давления (диапазон вакуума):  $0,02-0,070\text{ МПа}$

Низкий вакуум/средний расход



**Jiangsu Folee Medical Equipment Co., Ltd.**  
No. 16 Xingmao Road, 212009, Zhenjiang City,  
Jiangsu, People's Republic of China




Классификация продукции: Класс IIa

Электрическая классификация: тип I, класс B



Регистрационное удостоверение № 2020/9574 от «30» января 2020 года



SD472940-212



07/2021



Уполномоченный представитель на территории России: Общество с  
ограниченной ответственностью «Медтехника Реботек», 125222, г. Москва, ул.  
Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещение X, тел. +7 (495) 504-26-51



Аспиратор медицинский электрический  
портативный, зарегистрированный товарный знак  
MED-MOS



Модель H003-F

Энергоснабжение:  $230V \pm 10\% \sim 50\text{Гц} \pm 10\%$

Входная мощность:  $\leq 90\text{ВА} \pm 10\%$

Макс. отрицательное давление (макс. вакуум):  $\geq 0,075 \text{ МПа}$

Диапазон регулирования давления (диапазон вакуума):  $0,02 - 0,075 \text{ МПа}$

Низкий вакуум/средний расход



Jiangsu Folee Medical Equipment Co., Ltd.  
No. 16 Xingmao Road, 212009, Zhenjiang City,  
Jiangsu, People's Republic of China




Классификация продукции: Класс IIa

Электрическая классификация: тип I, класс B



Регистрационное удостоверение № 2020/9574 от «30» января 2020 года



GY113829-015



07/2021




Уполномоченный представитель на территории России: Общество с  
ограниченной ответственностью «Медтехника Реботек», 125222, г. Москва, ул.  
Генерала Белобородова, д. 35/2, этаж 1, помещение X, тел. +7 (495) 504-26-51



Управляющий: ИП Сирин И.В.  
Подпись \_\_\_\_\_










H002






H003-A




H003-B






H003-C




H003-D






H003-E




H003-F






**Мягкая аспирационная трубка**

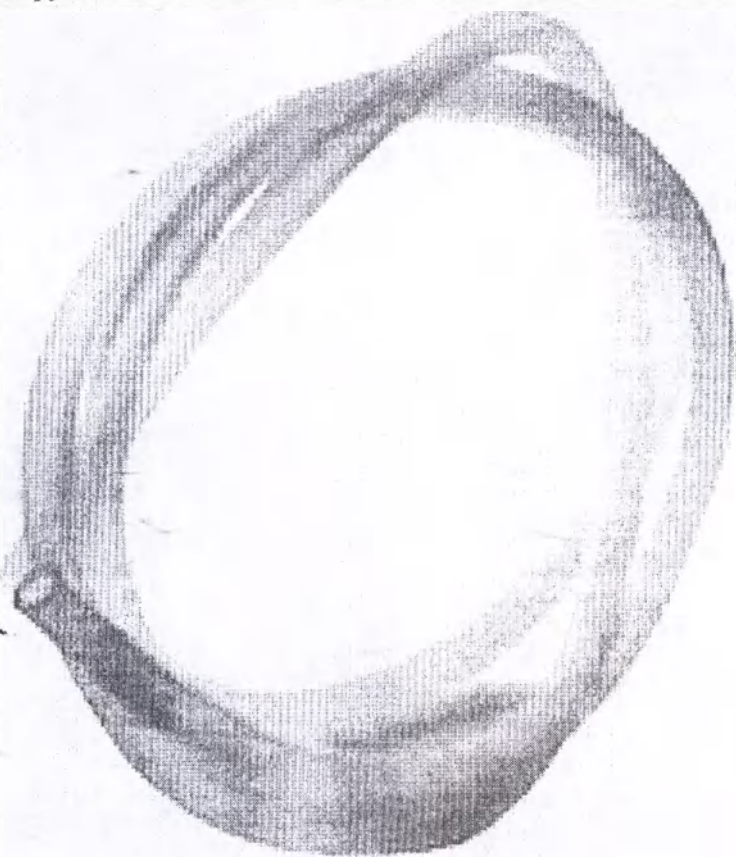

**Трубчатый плавкий предохранитель**





Кабель питания



Педальный выключатель





