


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода
 Candida в сыворотке (плазме) крови (Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-392-23548172-2012»


Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
 «22» 02 2022 г.
 АО «Вектор-Бест»
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

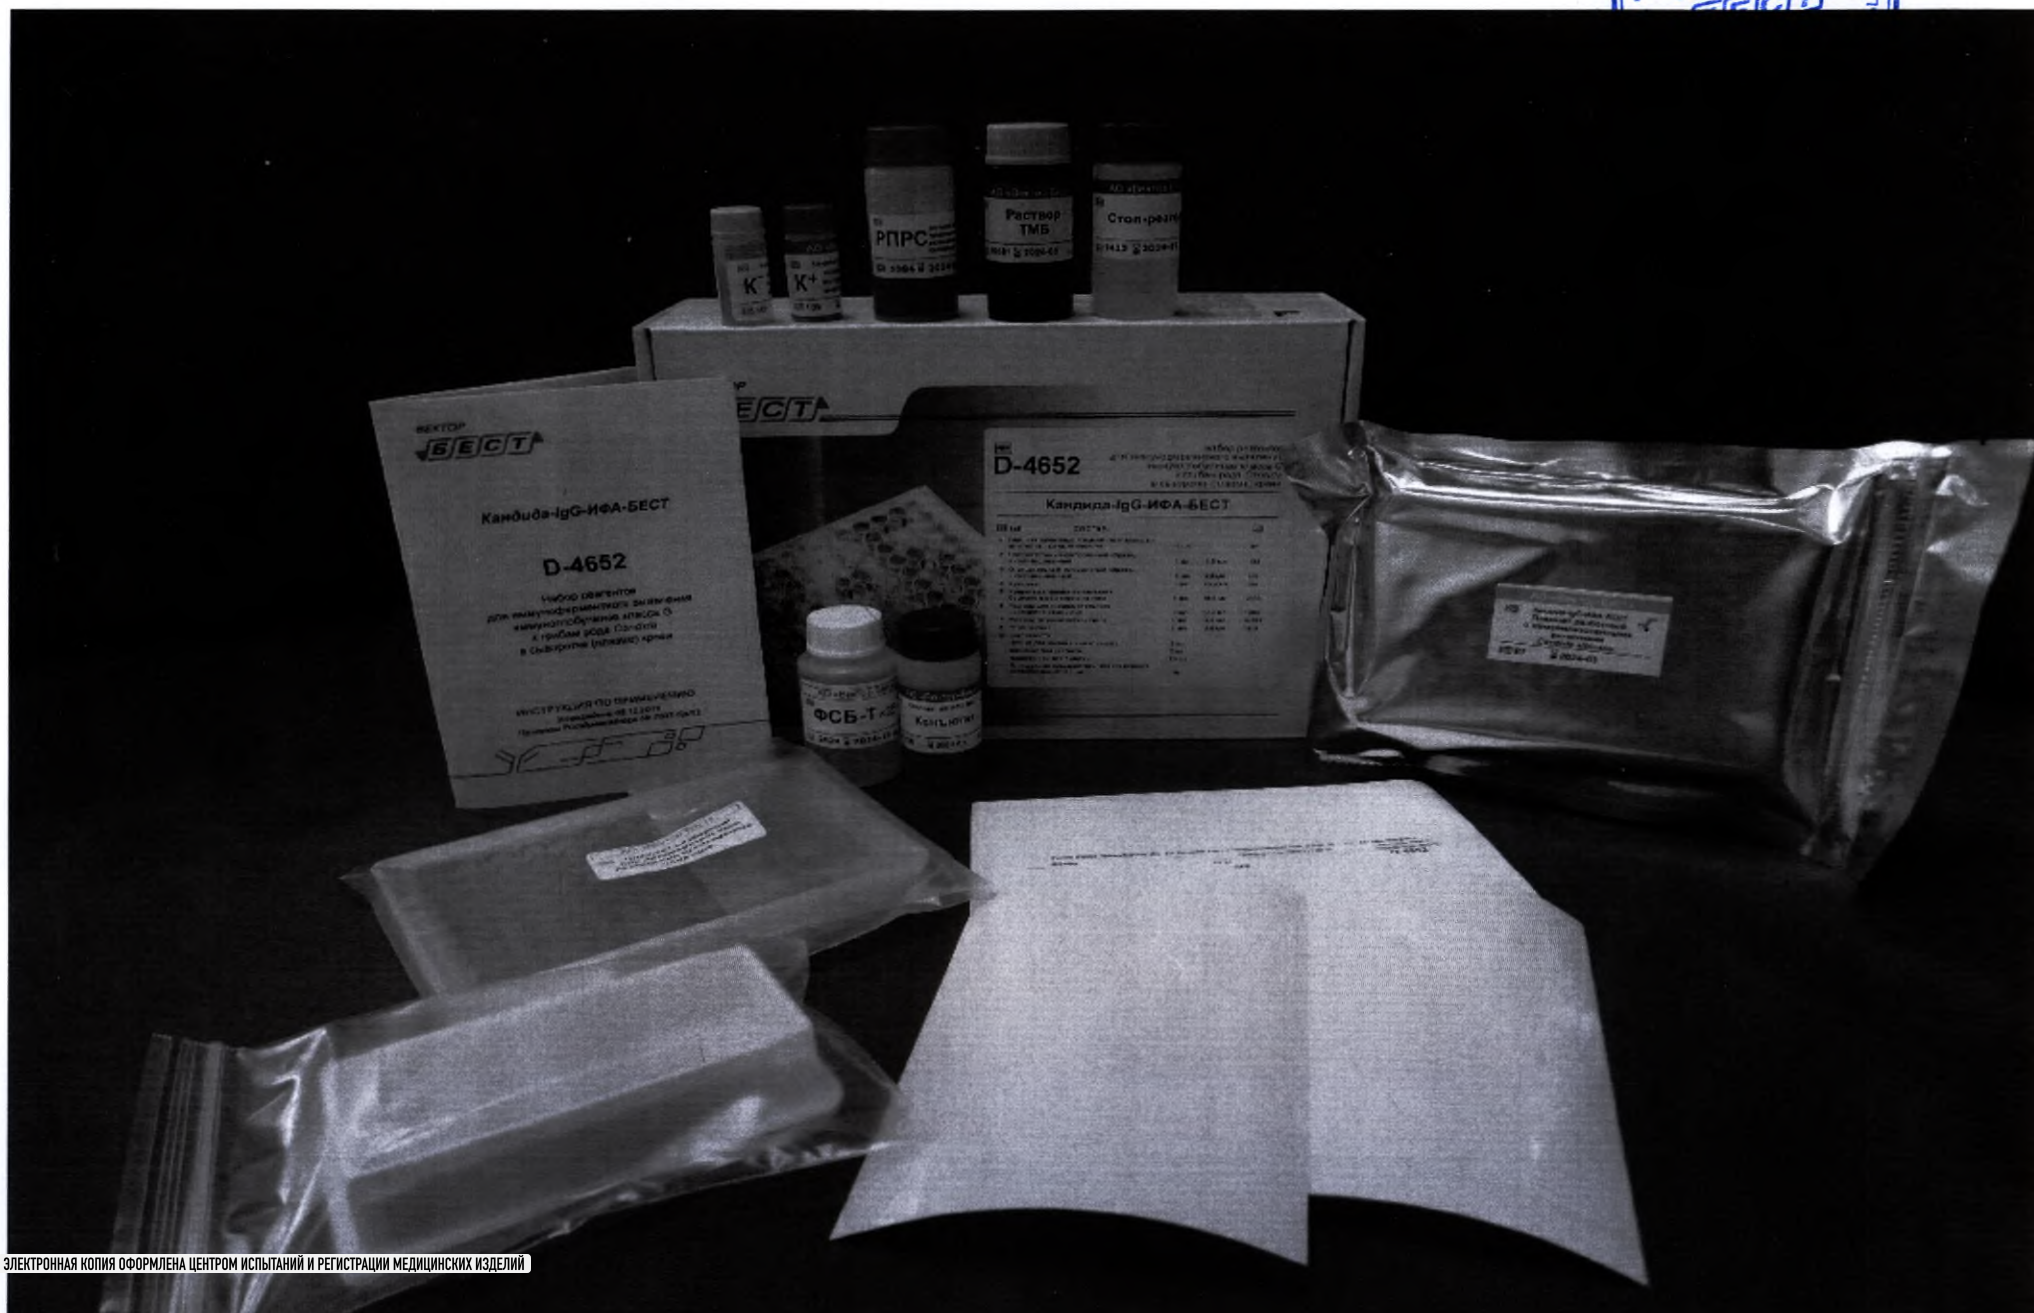

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода
Candida в сыворотке (плазме) крови (Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-392-23548172-2012» №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

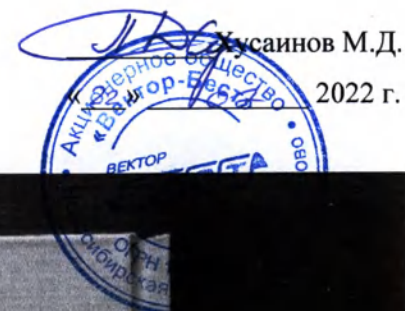

ВЕКТОР
БЕСТ



REF

D-4652

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к грибам рода *Candida*
в сыворотке (плазме) крови

Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ

LOT 140


СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Candida albicans</i>	1 шт.	87
2. Положительный контрольный образец инактивированный	1 фл. 1,5 мл	139
3. Отрицательный контрольный образец инактивированный	1 фл. 2,5 мл	151
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	136
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2933
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	1084
7. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	30581
8. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1413
Принадлежности:		
Пленка для заклеивания планшета	2 шт.	
Ванночка для реагента	2 шт.	
Наконечники для пипетки	16 шт.	
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.	


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода
Candida в сыворотке (плазме) крови (Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-392-23548172-2012» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

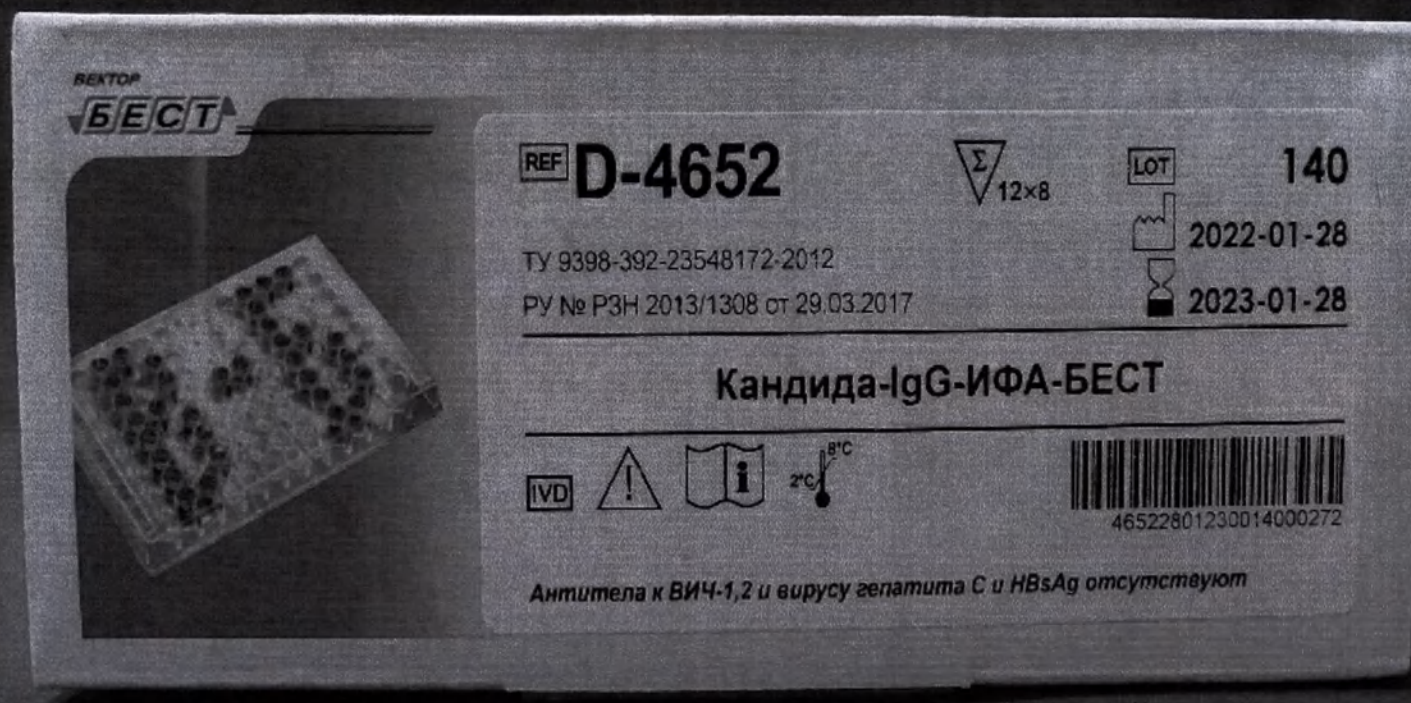

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода
Candida в сыворотке (плазме) крови (Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-392-23548172-2012» №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода
Candida в сыворотке (плазме) крови (Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-392-23548172-2012» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода
Candida в сыворотке (плазме) крови (Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-392-23548172-2012» №3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода
Candida в сыворотке (плазме) крови (Кандида-IgG-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-392-23548172-2012» №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2022 г.

