


Фотографические изображения медицинского изделия

«Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных процедур, включающих: ангиографию, ангиопластику, тромбэктомию и стентирование»

Катетеры диагностические TEMPO AQUA

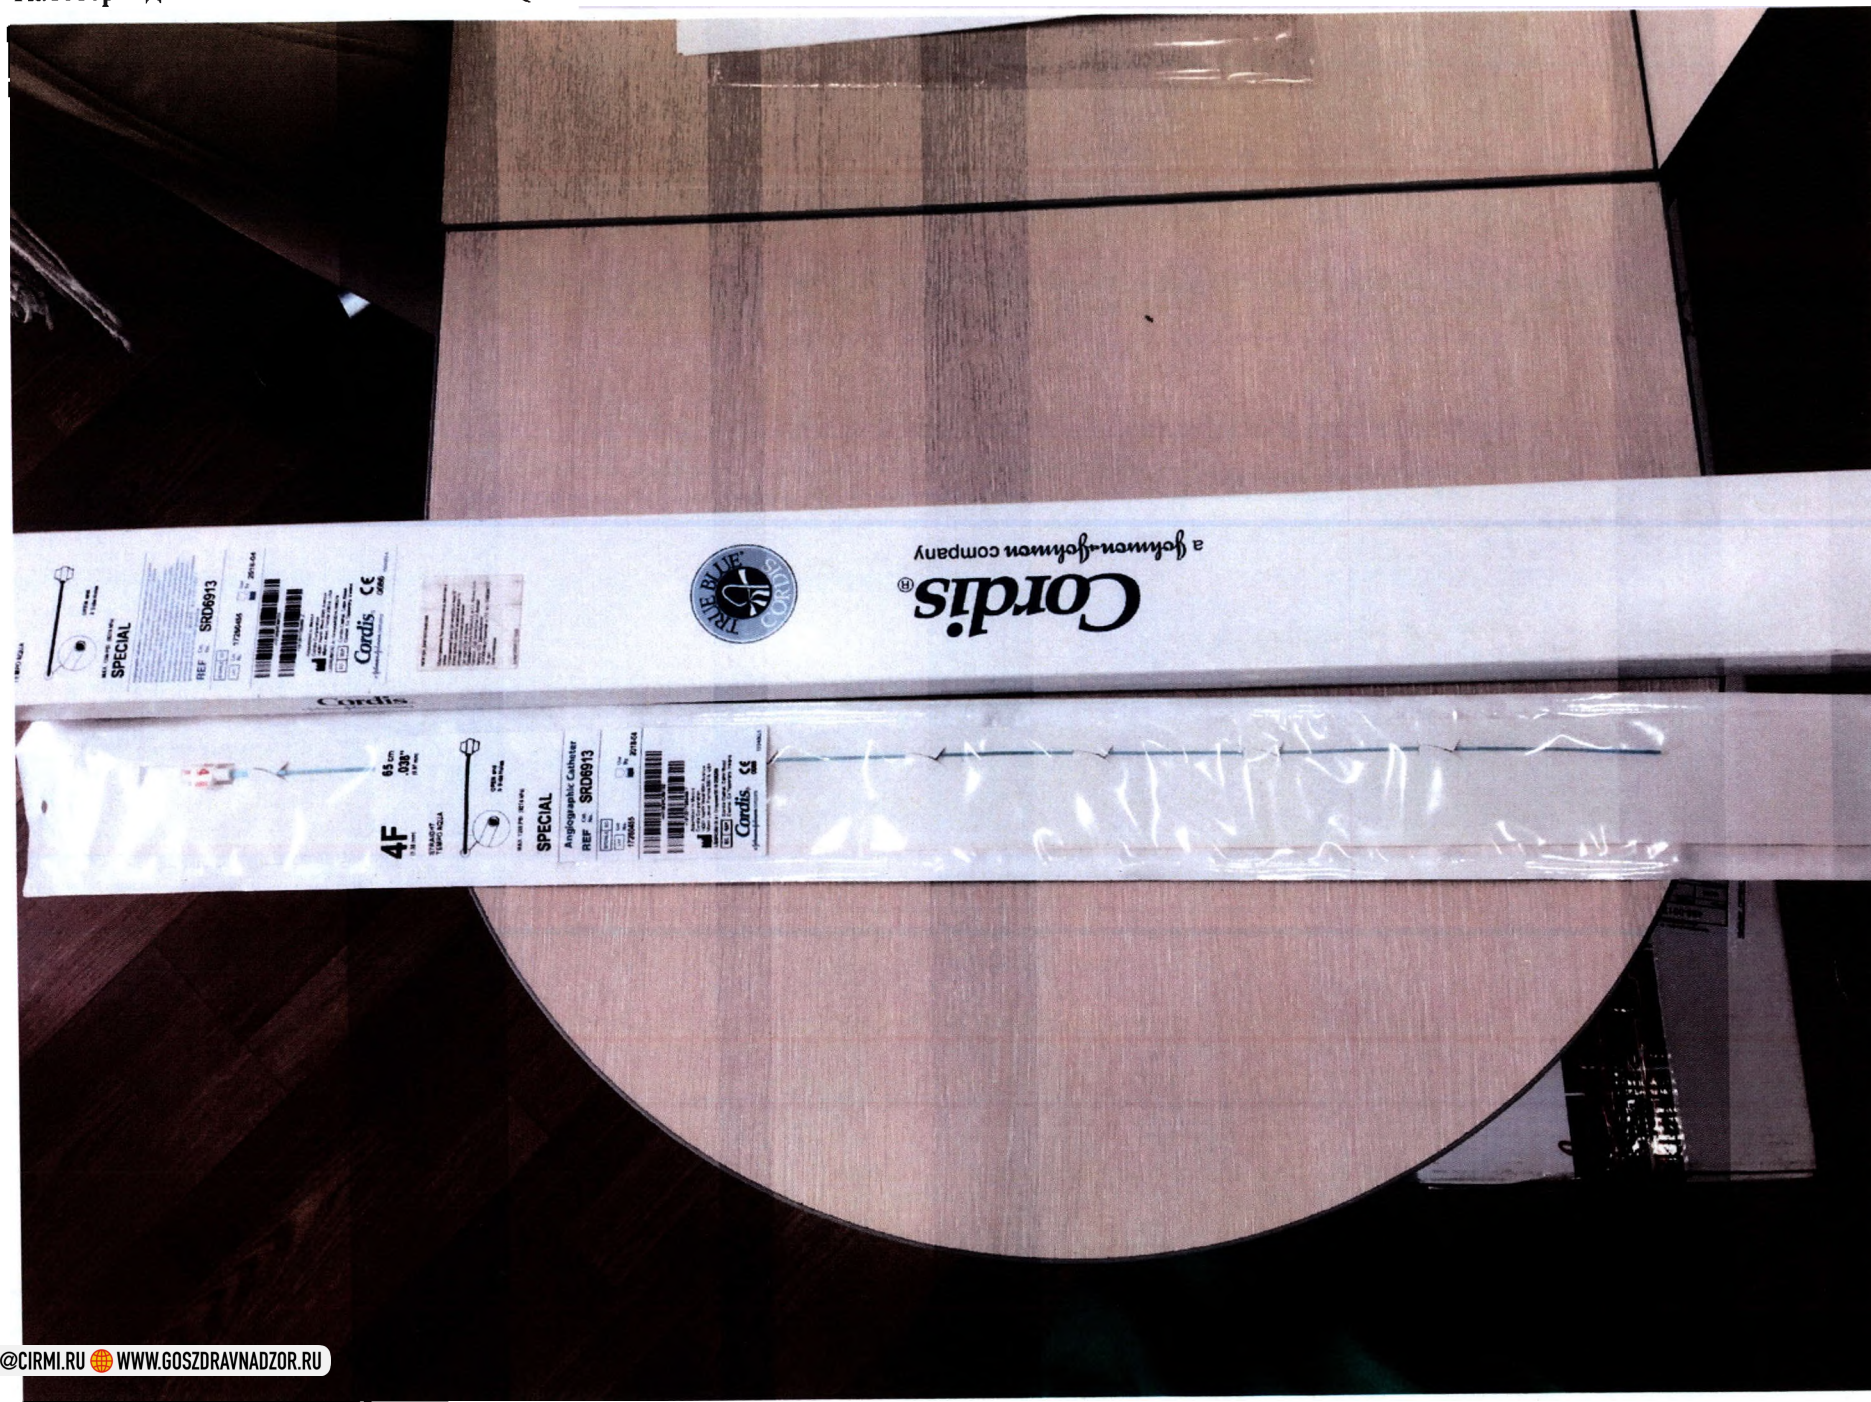

Катетеры диагностические TEMPO AQUA



катетеры диагностические

Область применения: Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°.

Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не использовать после истечения срока хранения.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Cordis Corporation., США

Импортер: ООО "Джонсон&Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3272

Орган сертификации:

Артикул SRD6913 15205



CORUS®
Johnson company

Arulz2150123 20:20 FP

1537479.2

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер диагностический

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015




Артикул 451407V0 16306

Sample ONLY.
Not For Resale!



Катетеры диагностические HIGH FLOW

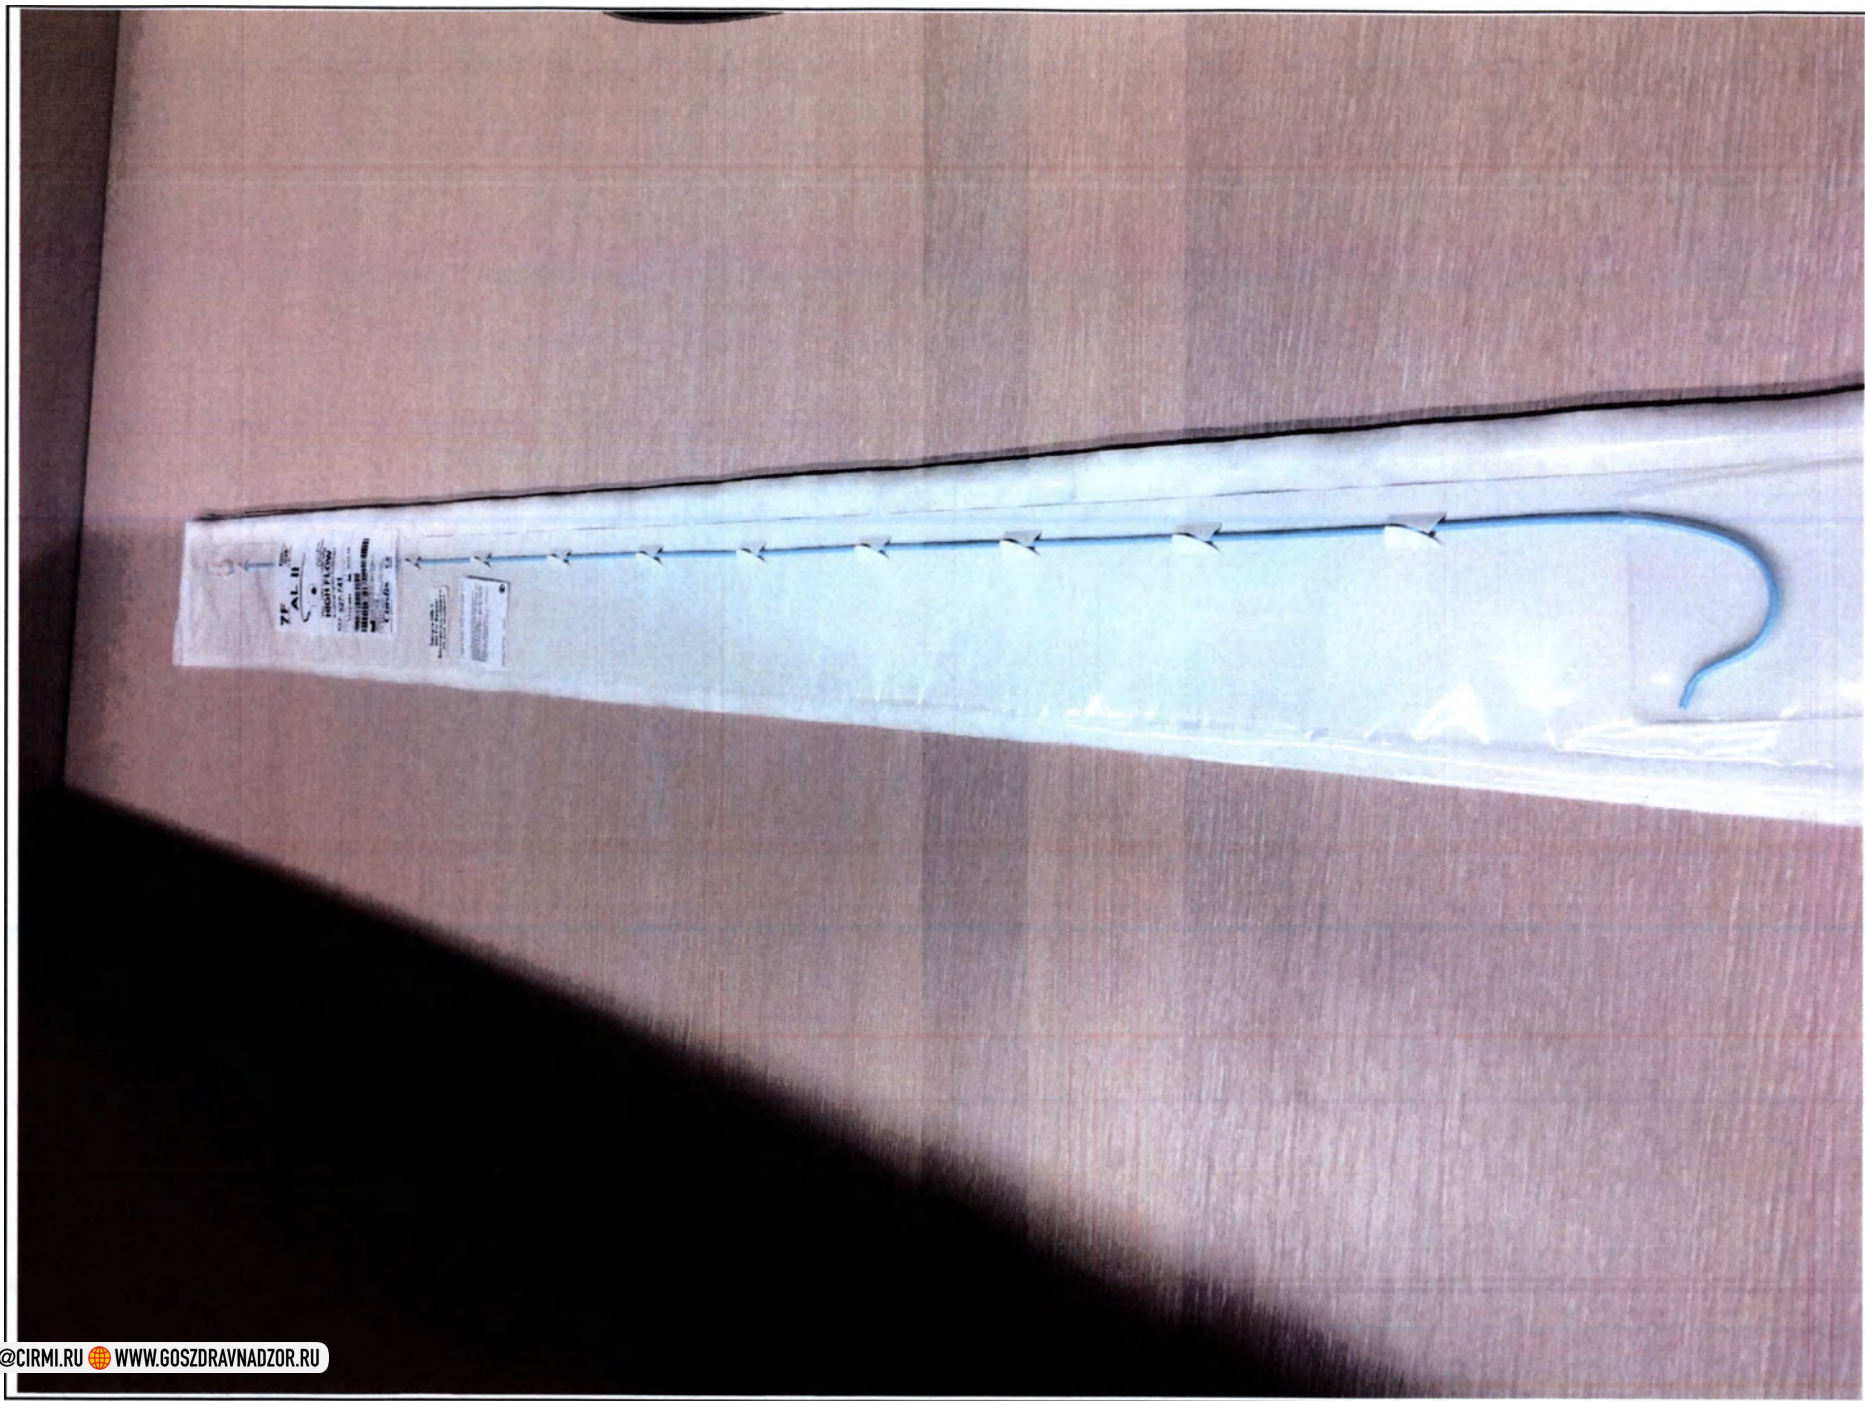

**Sample ONLY.
Not For Resale!**
**Бесплатный образец.
Не для продажи!**

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер диагностический


Область применения: для доставки рентгеноконтрастного
вещества в заданный участок сосудистой системы
Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике
Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777
Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 527741 16306



Катетеры диагностические INFINITI

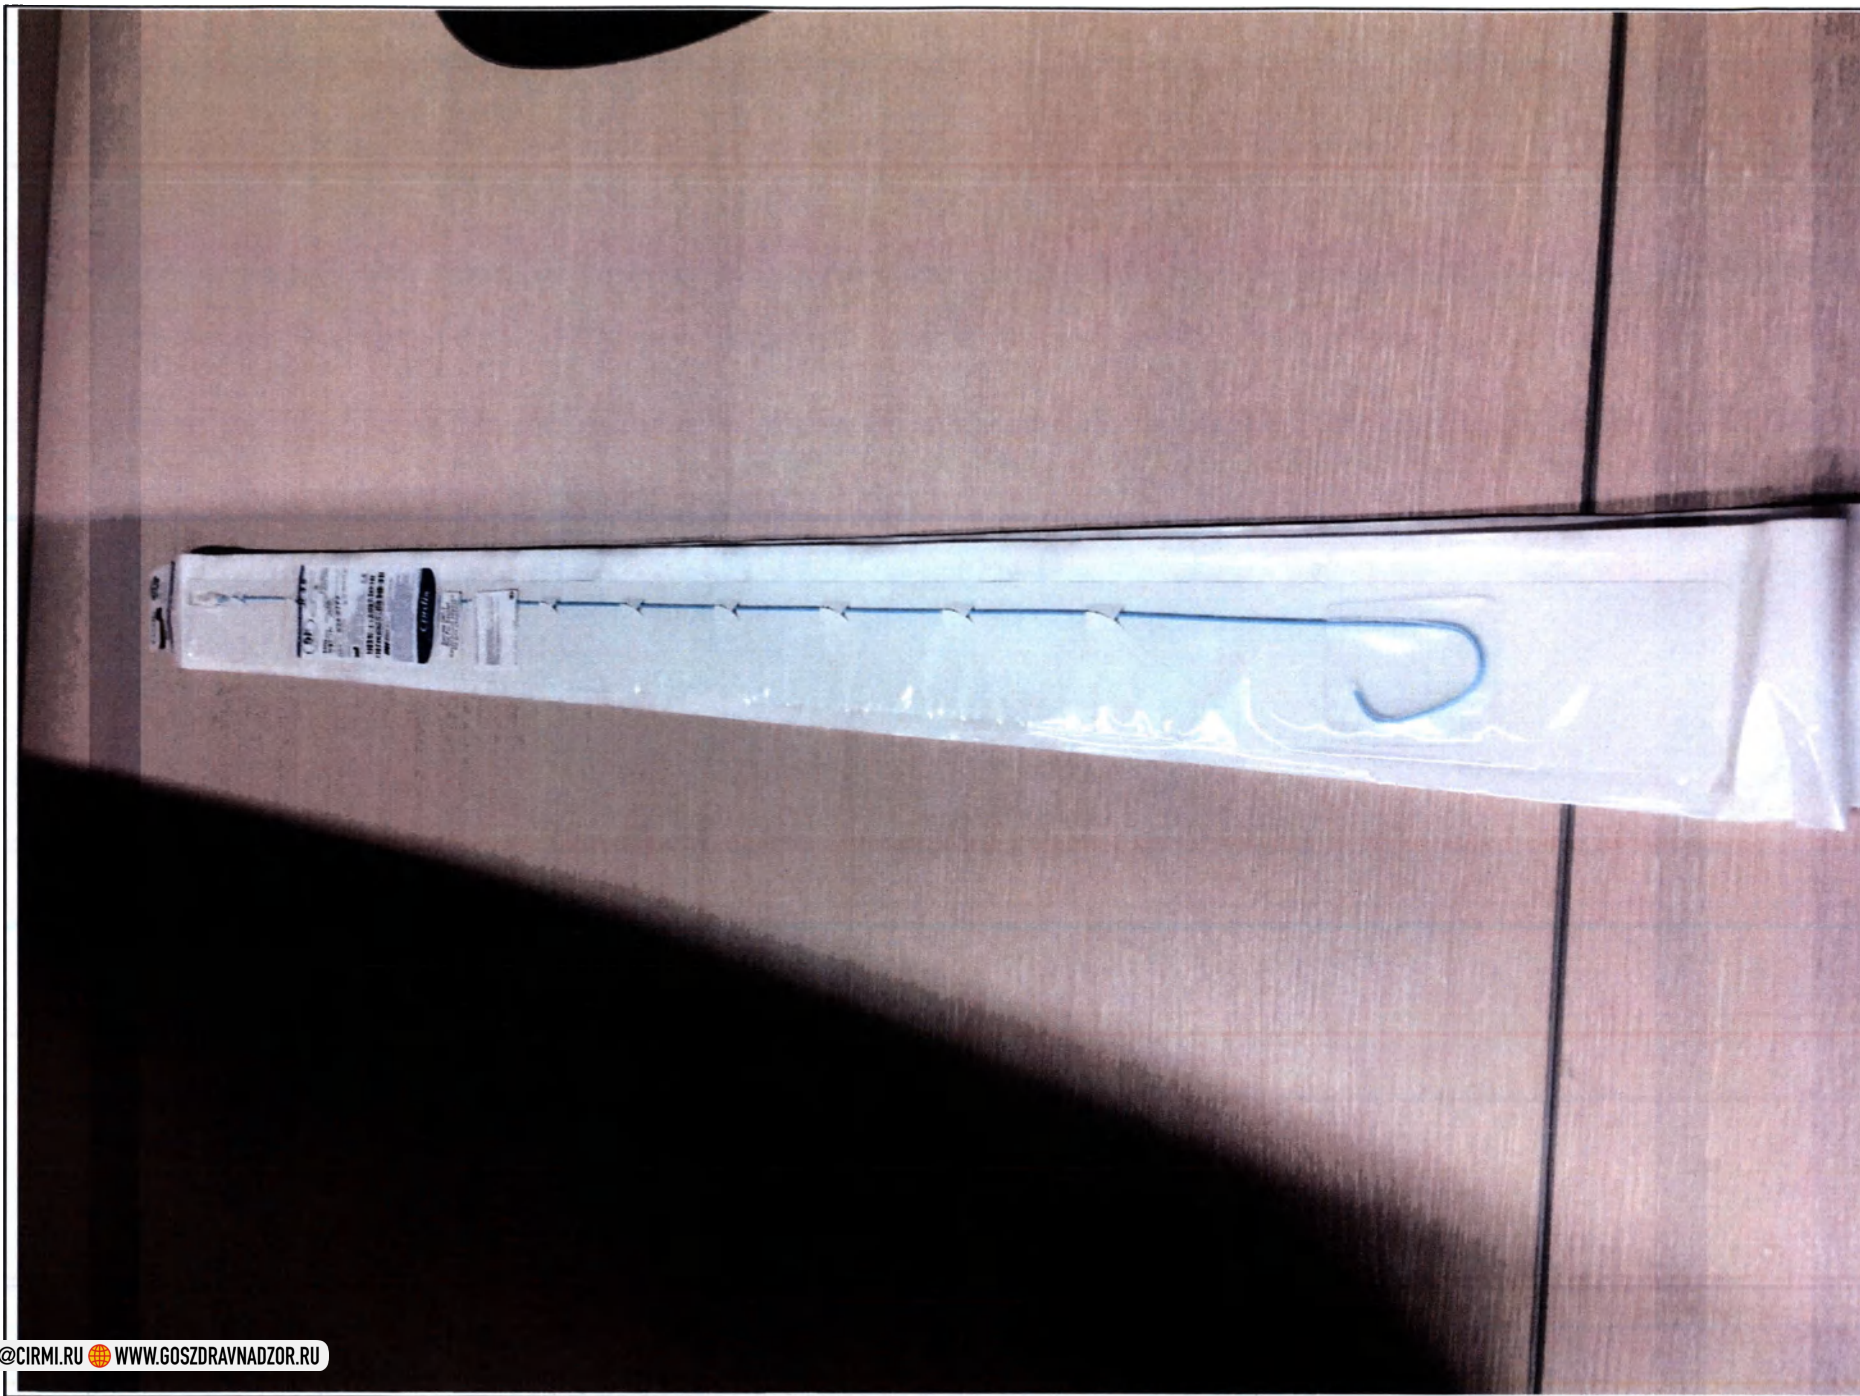

Не для продажи!

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер диагностический

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 534517T 16306

Катетеры диагностические NYLEX



Diagnostic Catheter
 Cathéter diagnostique / Diagnostischer Katheter / Catetere diagnostico
 Cateter de diagnóstico / Diagnostiekkatheter / Diagnostisk kateter
 Diagnostinen katetri / Cateter de Diagnóstico / Diagnostikkateter
 διαγνωστικός Καθετήρας / 診断用カテーテル

STERILE **STERILE**

STERILE EO Sterilized with ethylene oxide gas.

 For one use only.

REF Catalog No.

LOT Lot No.

 Use By

 Attention, see Instructions for Use.

 Nonpyrogenic

RADIOPAQUE

DO NOT RESTERILIZE.



Do not use open or damaged packages.



Store in a cool, dark, dry place.

Rx Only

4F
(1.35 mm)

100 cm
.035"
(0.89 mm)

STR



Open End
8 Sideholes

Max. 1050 psi (7240 kPa)

NYLEX

Angiographic Catheter

REF 526-422

Cat. No.

LOT Lot No.
17385477

 Use By
2018-11



(01)10706032010897



(17)181130(10)17386477

Assembled in Mexico
Cordis Corporation, 14201 NW 60th Ave.
Miami Lakes, Florida 33014, USA

EC REP Cordis Cathel, Cath Road
Cathel, Co Tipperary, Ireland

LB628422.1.6_00180

piratevez161206 10:30 FP

Cordis
a Johnson & Johnson company

CE
0086

1537381.2

**Устройства для рентгеноваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер диагностический**

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.

Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015




Артикул 526422 16340

Sample ONLY.


Not For Resale!

Бесплатный образец.

Катетеры диагностические SUPER TORQUE

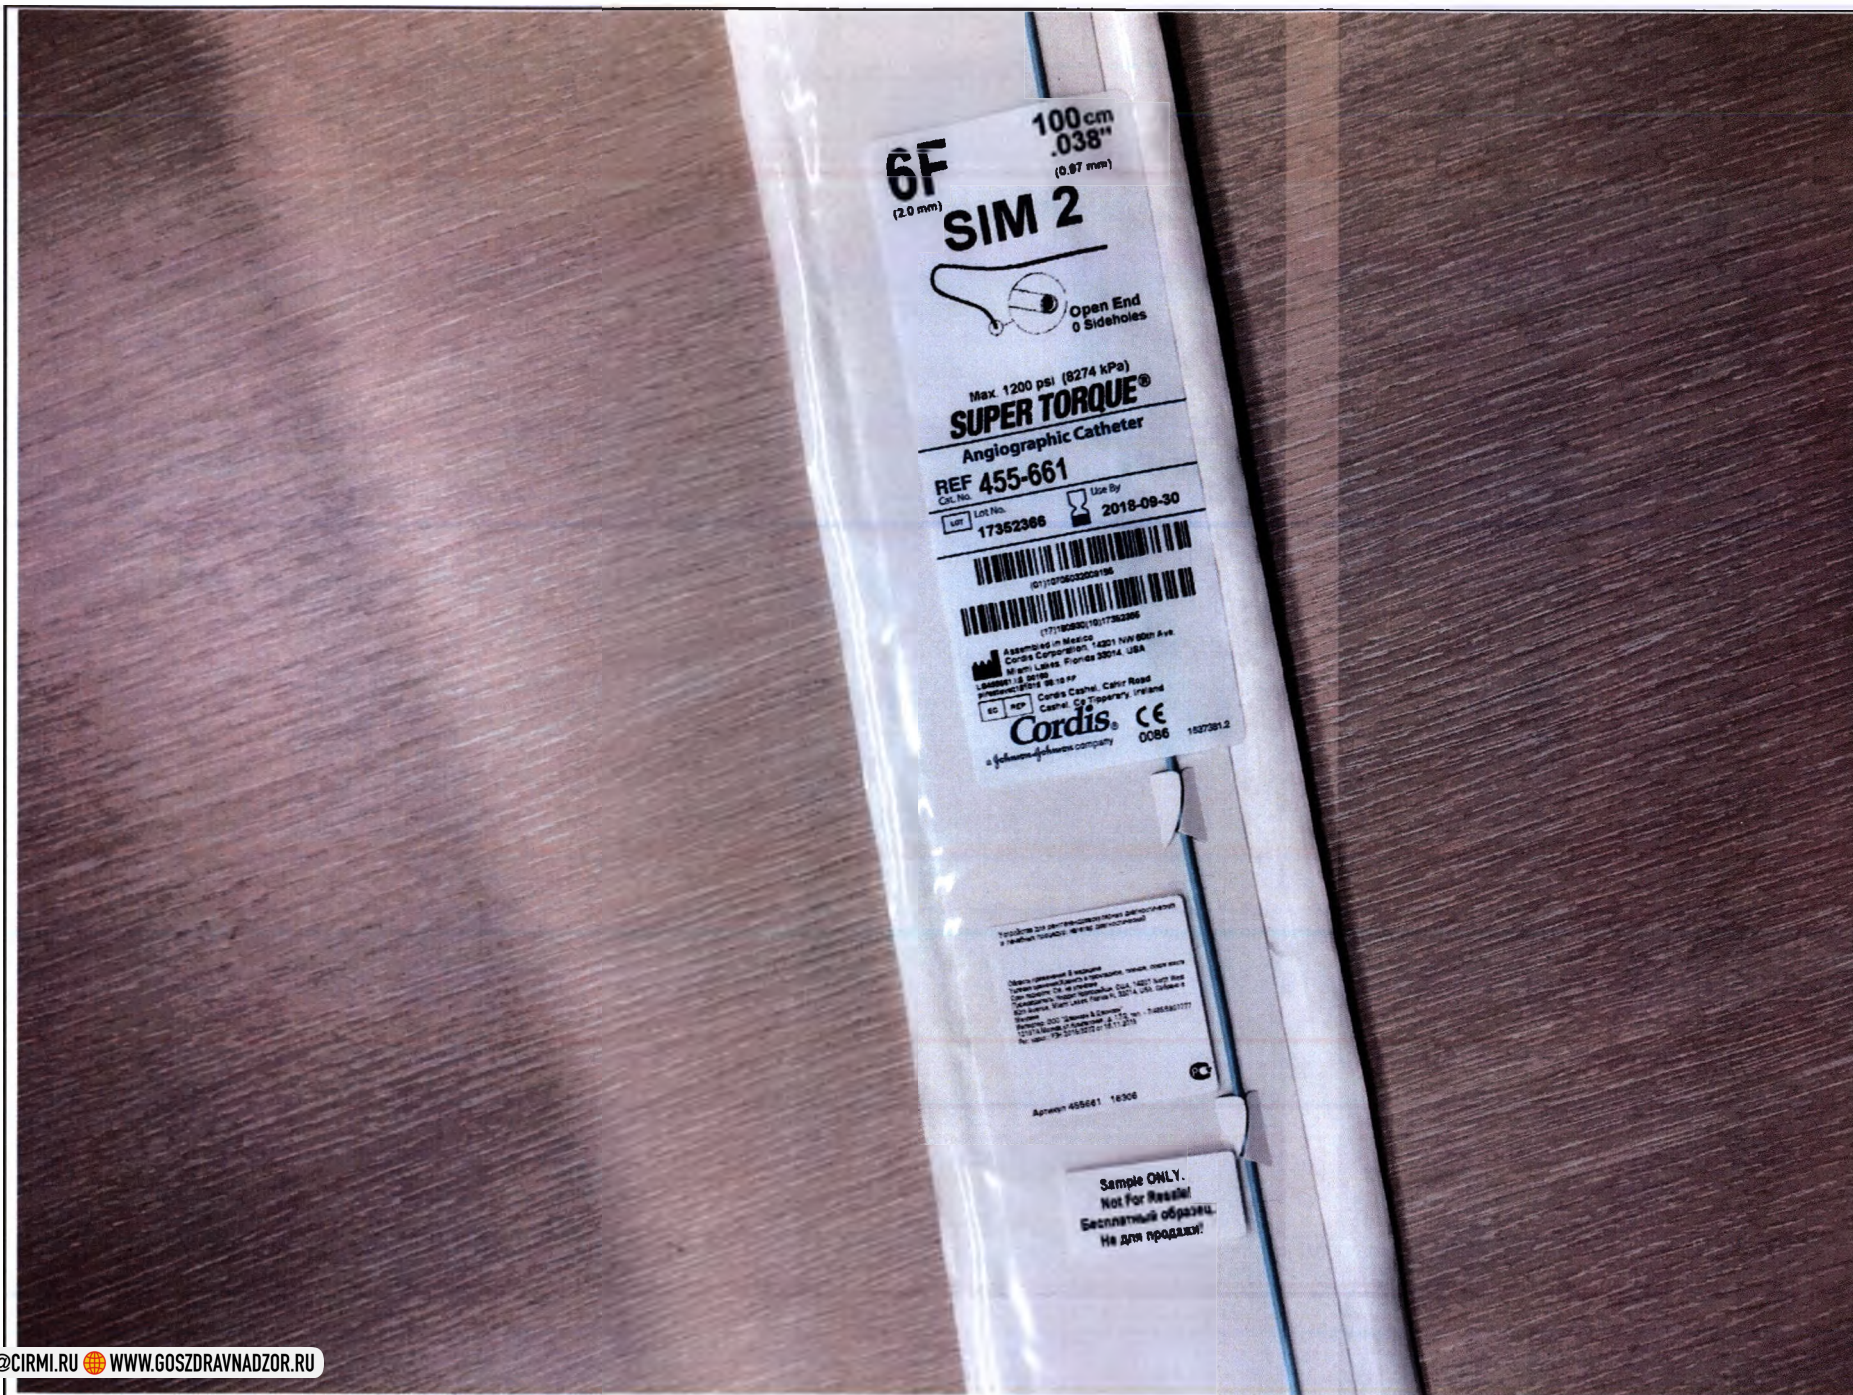

Катетеры диагностические SUPER TORQUE

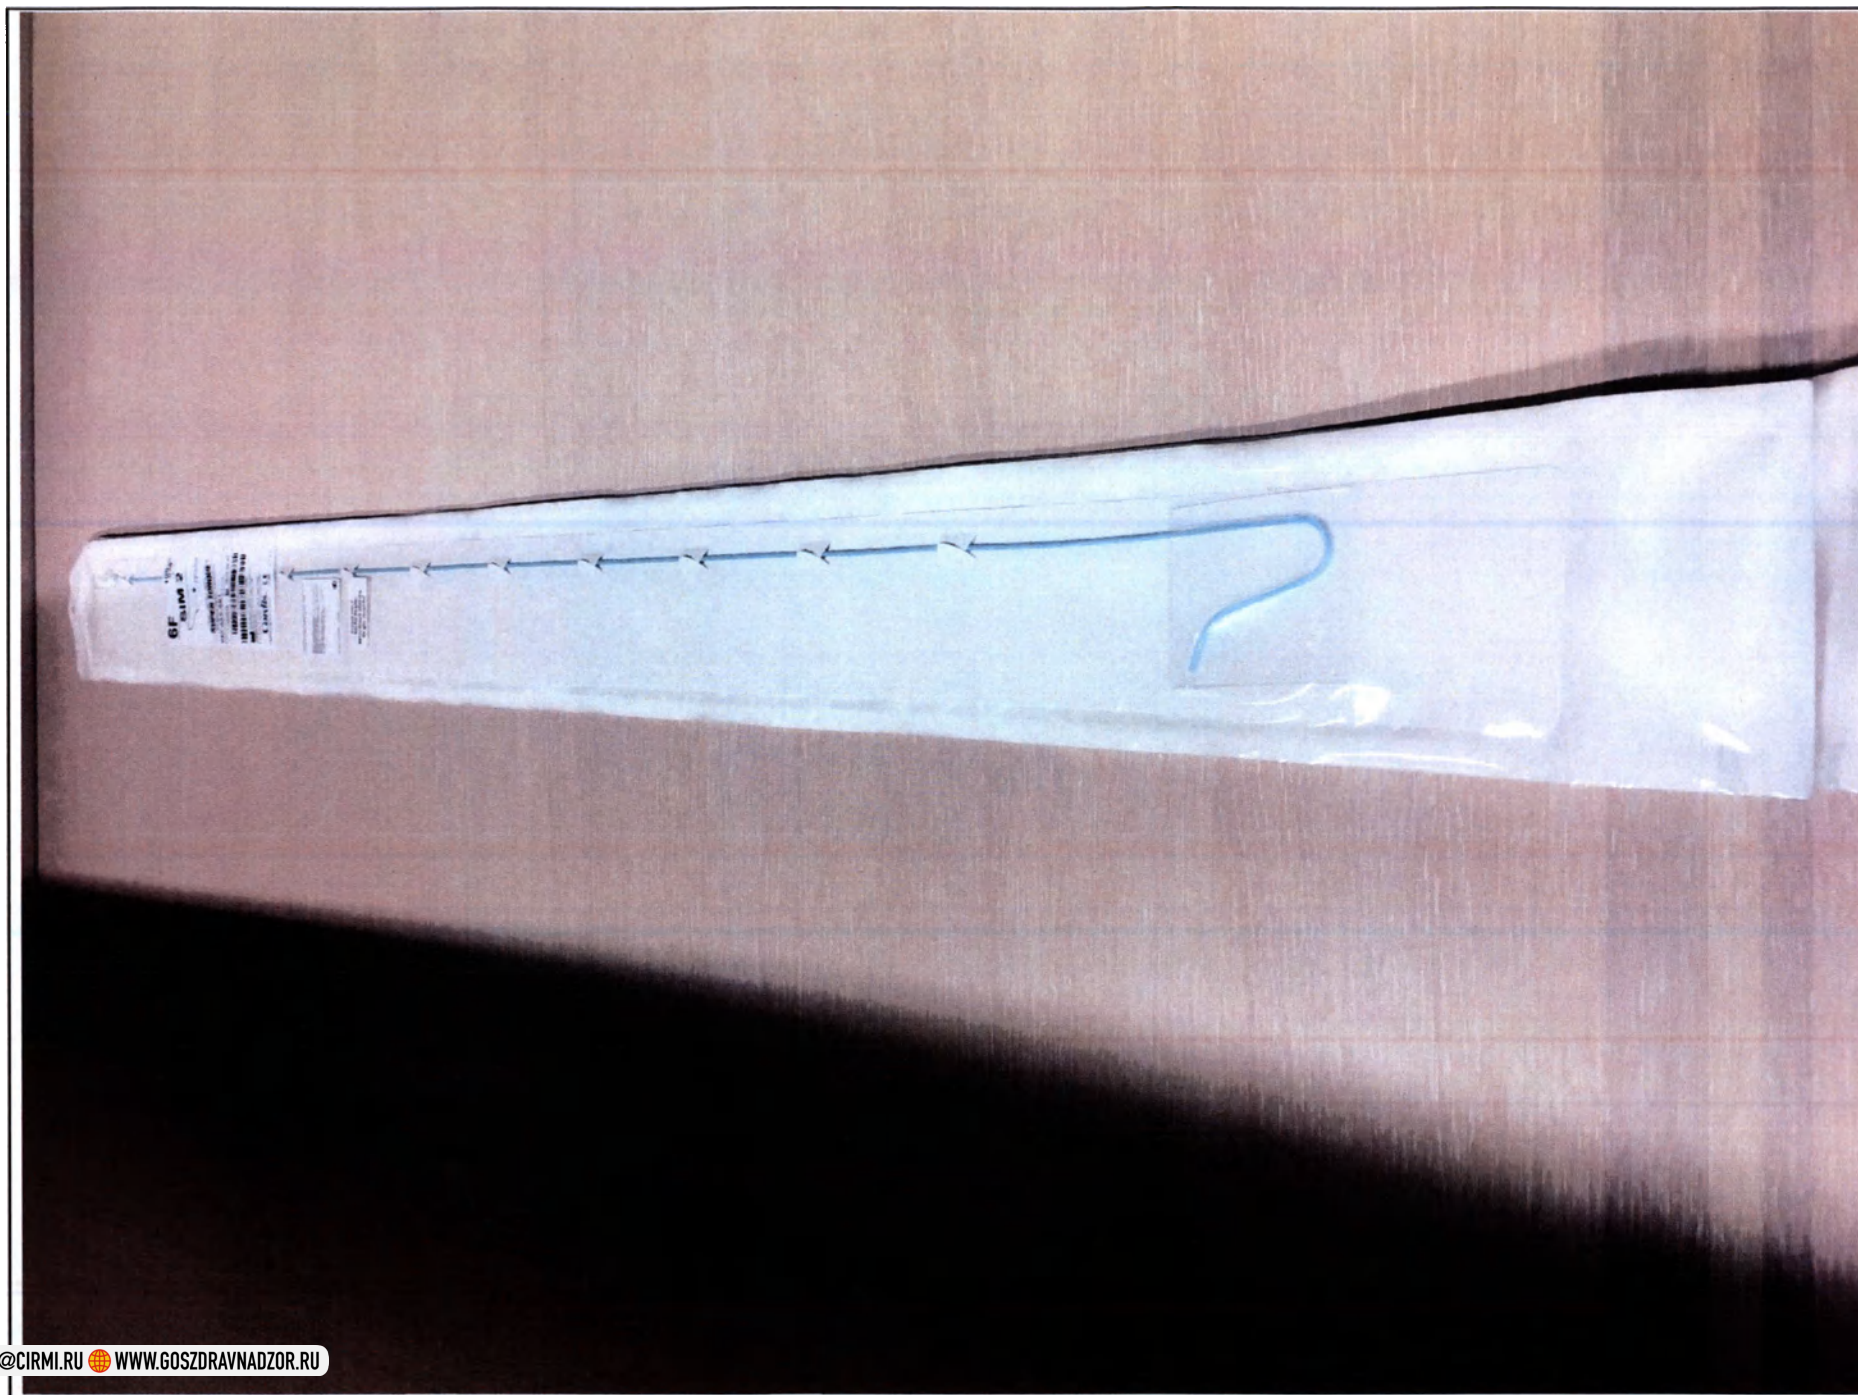

Катетеры диагностические SUPER TORQUE


Устройства для рентгеноваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер диагностический

Область применения: В медицине
Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике
Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777
Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015




Артикул 455661 16306

Катетеры диагностические SUPER TORQUE PLUS

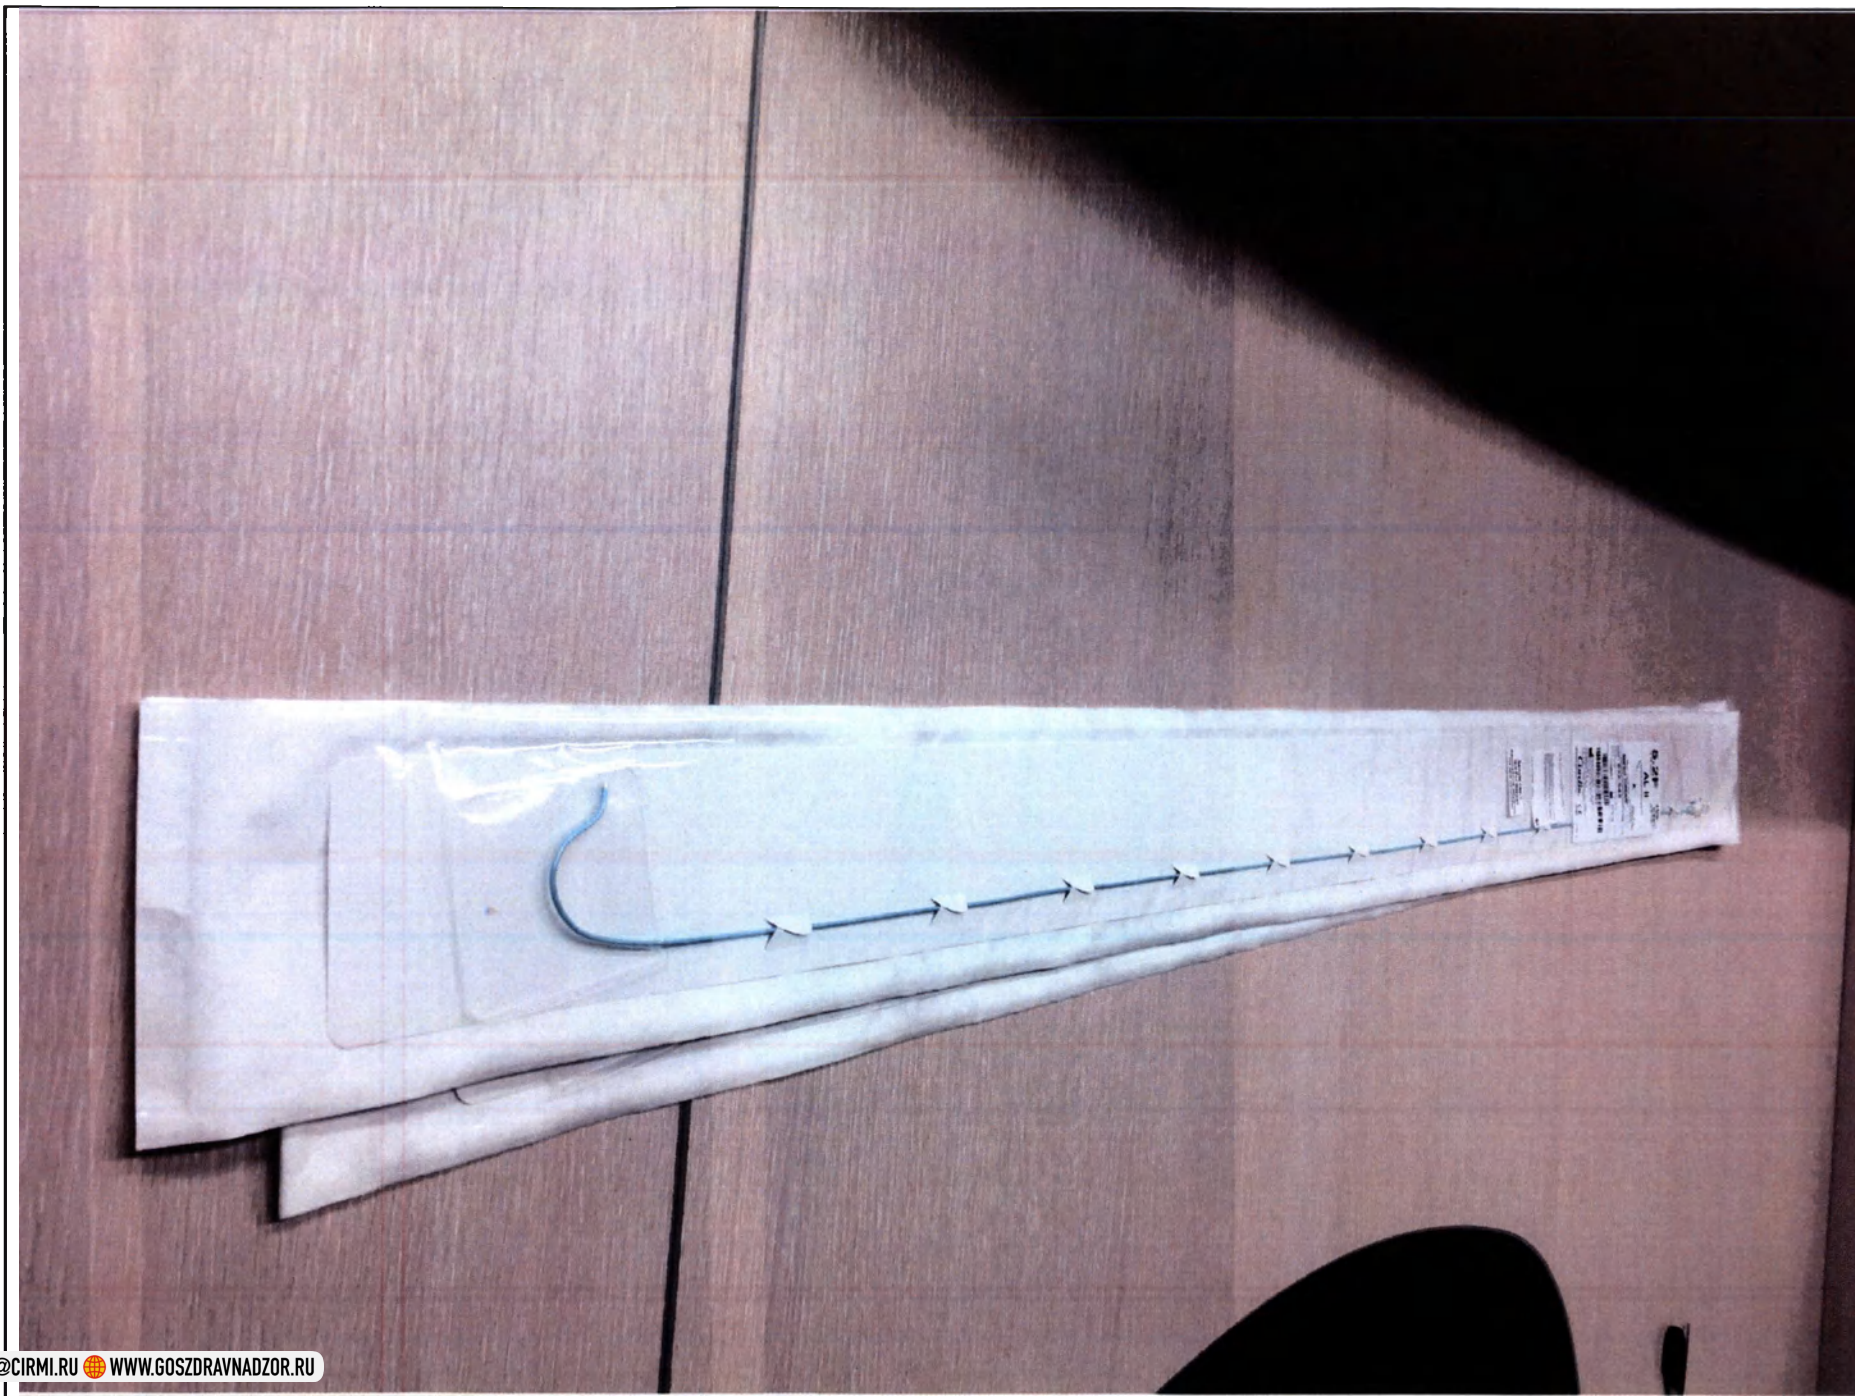


Катетеры диагностические SUPER TORQUE PLUS

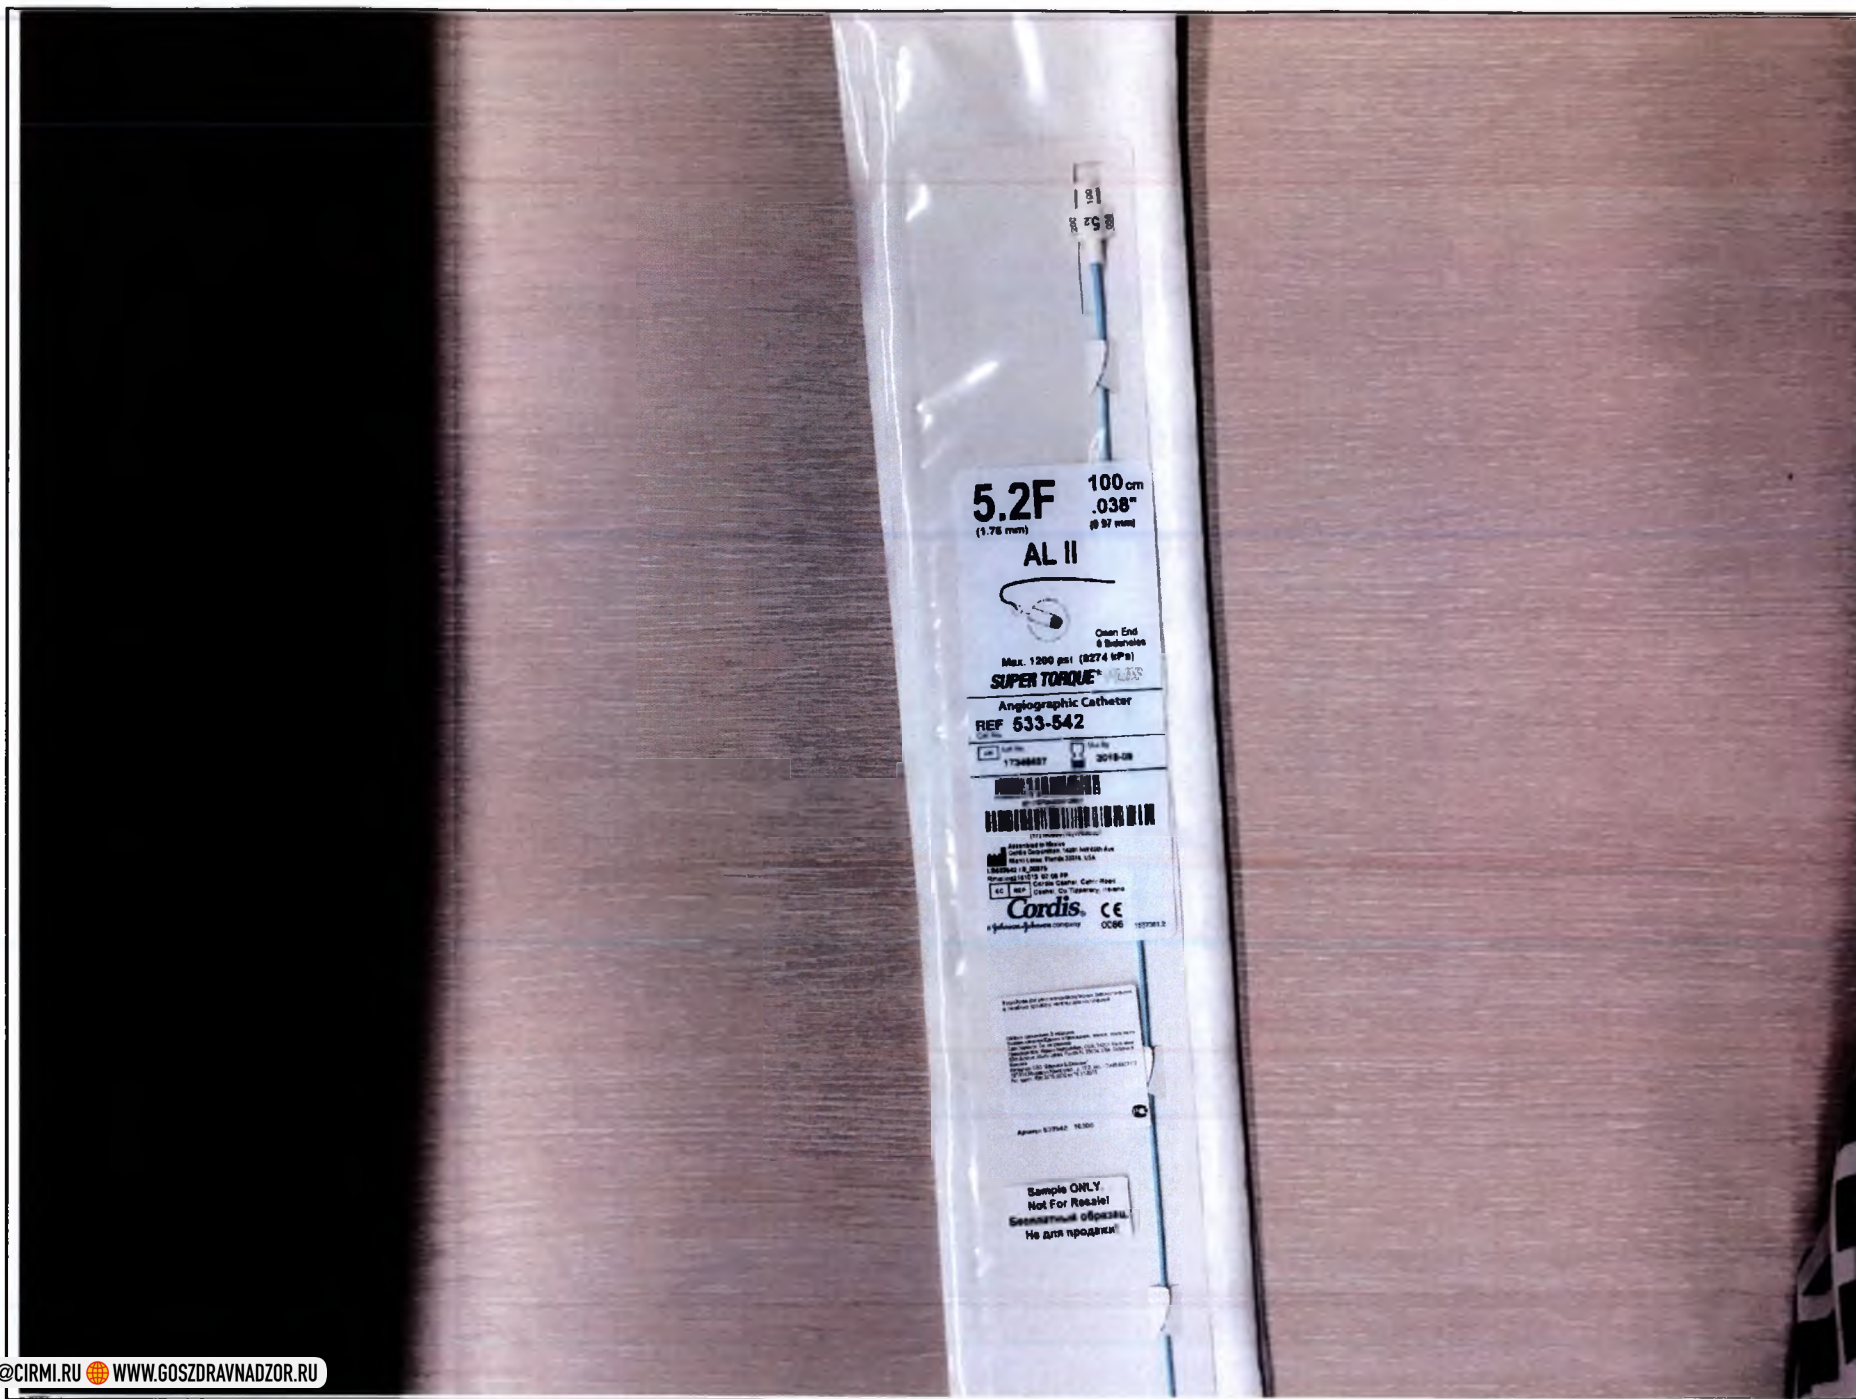

LB533542.1.8_00976

Rmolina2151013 07:05 FP



Cordis Cashel, Cahir Road
Cashel, Co Tipperary, Ireland

Cordis®

a Johnson & Johnson company



0086

1537381.2

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер диагностический

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Per. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 533542 16306


Катетеры диагностические SUPER TORQUE MB



5F
(1.65 mm)

110 cm
.038"
(0.97 mm)

PIG



10 Markers



Open End

Max. 1200 psi (8274 kPa) 6 Sideholes

SUPER TORQUE® MB

Angiographic Catheter

REF 532-598A

Cat. No.




Lot No.
17540645



Use By
2019-06-30



(01)10706032012027



(17)180630(10)17540645

Assembled in Mexico
Cordis Corporation, 14201 NW 80th Ave
Miami Lakes, Florida 33014 USA
L803200A.13 00307
ehemad1180721 04 40 FP

EC Cordis Cashel, Cahir Road
Cashel, Co Tipperary, Ireland

Cordis®

CE

a Johnson-Johnson company

0086

1537391.2

a Johnson-Johnson company

Cordis®

EC

REP

Cordis Cashel, Cahir Road
Cashel, Co Tipperary, Ireland

0086

Cordis®

a Johnson & Johnson company

LB532598A.O.8_00070
eherna41160721 04:58 FP

1537479.2

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер диагностический

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
80th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Per. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 532598A 16266

Angiographic Catheter Extension

65 cm

REF Cat. No. 502-101D

STERILE EO Method of Sterilization: ETO

LOT Lot No. 17548633 Use by 2019-07-31

LB502101D.L7_00516
restervez160801 06:50 FP

Cordis
a Johnson & Johnson company

Assembled in Mexico
Cordis Corporation
14201 NW 80th Ave.
Miami Lakes, FL
33014, USA

EC REP Cordis Cashel, Cahir Road
Cashel, Co Tipperary, Ireland

(01)10705032064712

CE
0086

(17)190731(10)17548633

1532884.3

Diagnostic Catheter
Cathéter diagnostique / Diagnostischer Katheter / Catetere diagnostico
Catéter de diagnóstico / Diagnostiekkatheter / Diagnostisk kateter
Diagnostinen katetri / Cateter de Diagnóstico / Diagnostikkateter
Διαγνωστικός Καθετήρας / 診断用カテーテル

STERILE STERILE

STERILE EO Sterilized with ethylene oxide gas.

⊗ For one use only.

REF Catalog No.

LOT Lot No.

⌚ Use By

⚠ Attention, see Instructions for Use.

⊗ Nonpyrogenic

RADIOPAQUE

DO NOT RESTERILIZE.




Do not use open or damaged packages.



Store in a cool, dark, dry place.

Rx Only



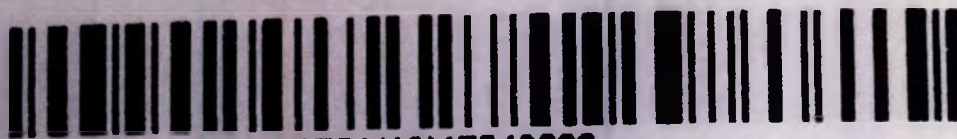

(17)190731(10)17548633

1532885.3

Устройства для рентгеноваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер диагностический

Область применения: в медицине, для присоединения
ангиографического катетера к инъектору высокого давления
Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
80th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике
Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатовая, д. 17/2, тел. +7(495)5807777
Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015




Артикул 502101D 16340

**Sample ONLY.
Not For Resale!**
Бесплатный образец.





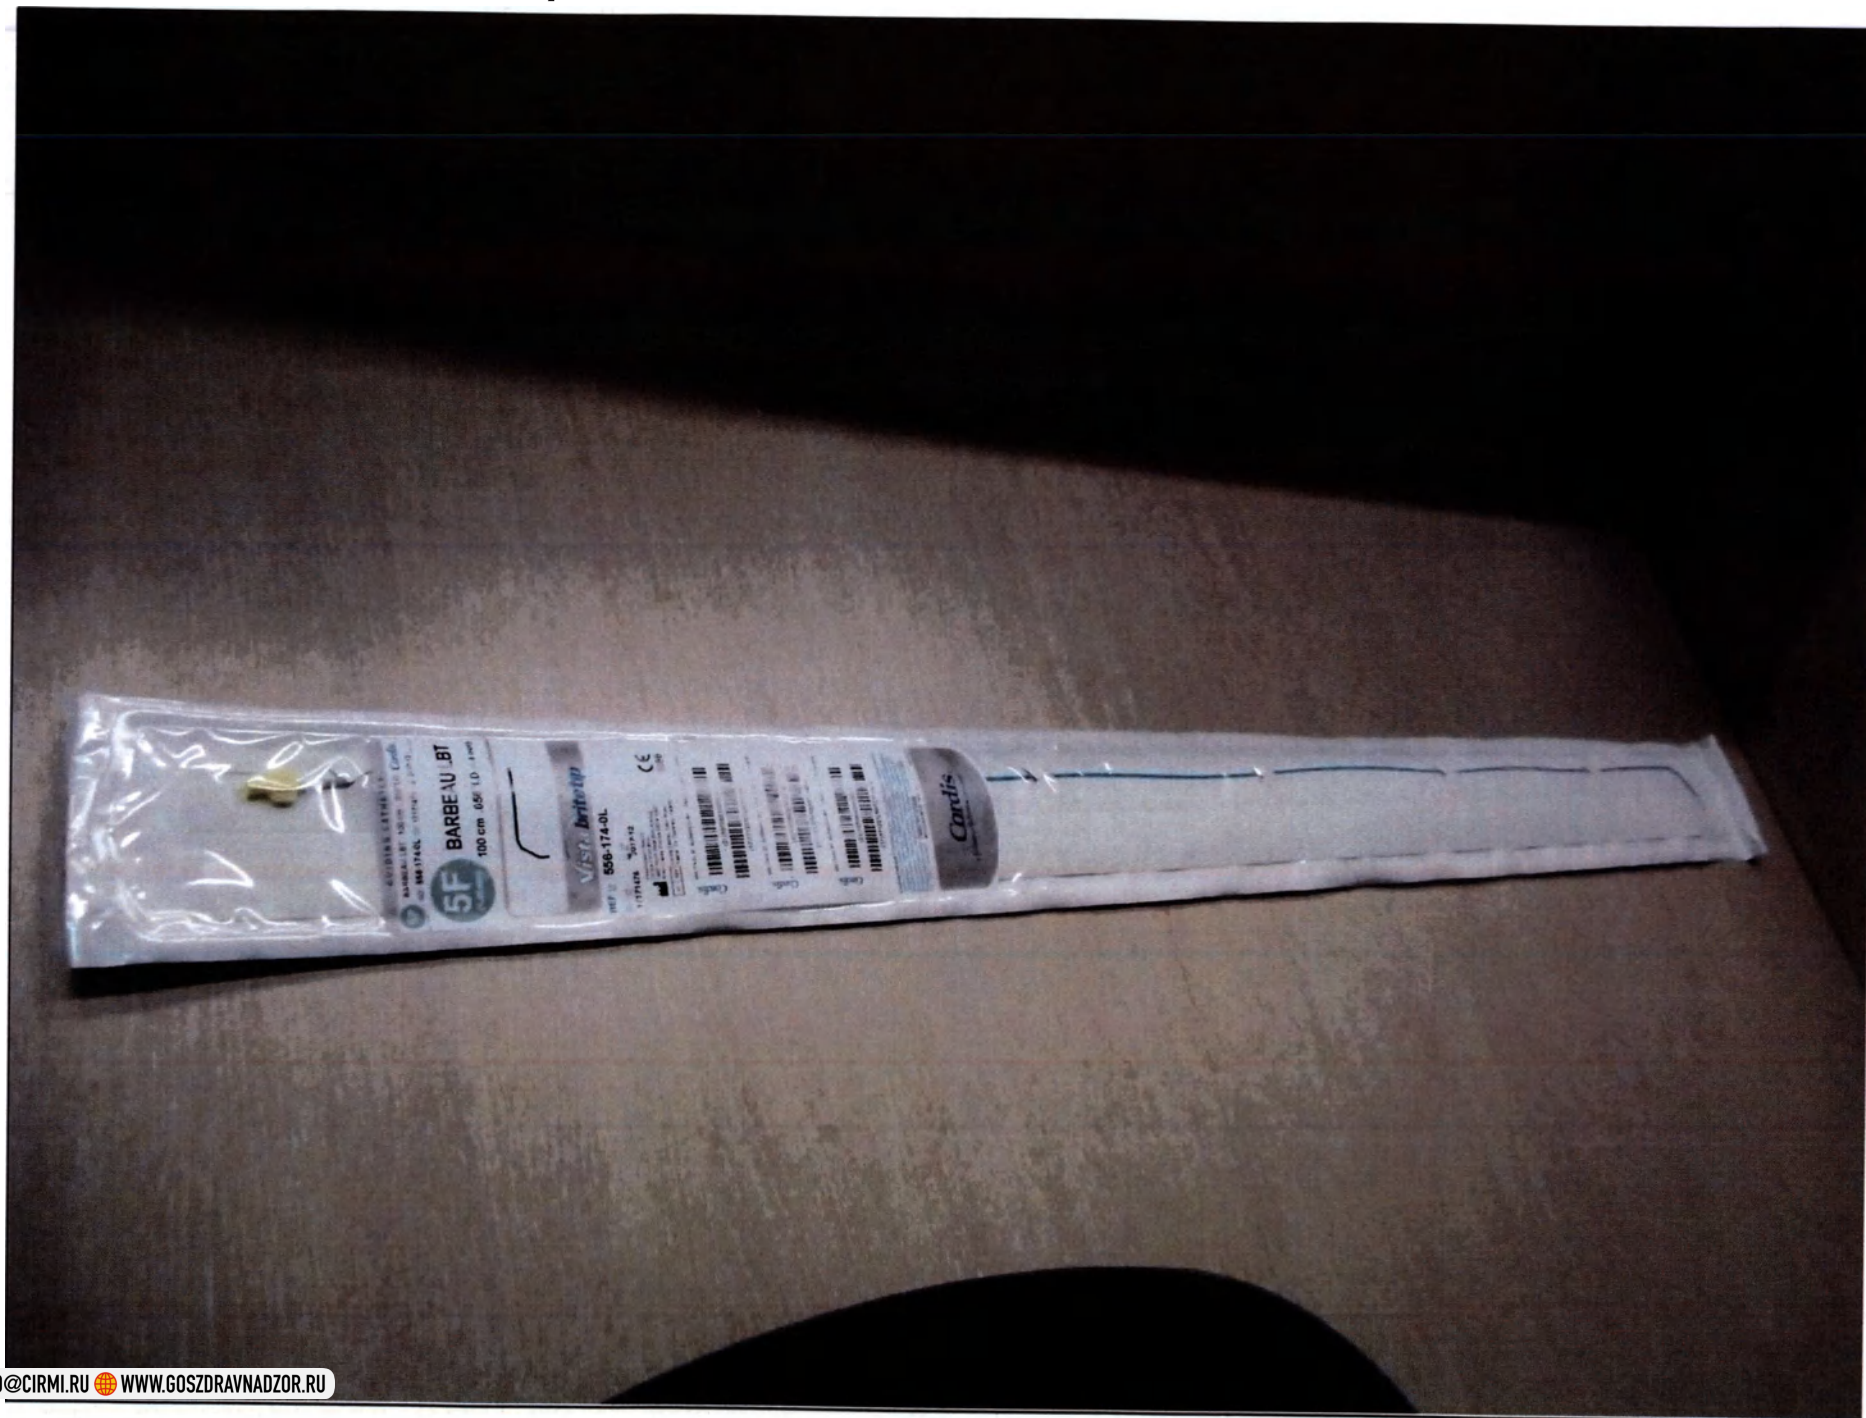

Катетер проводниковый

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°

Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не использовать после истечения срока хранения.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Cordis Corporation, USA.

Импортер: ООО "Джонсон&Джонсон"


121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3272

Орган сертификации: -



Артикул 5561740L 15149

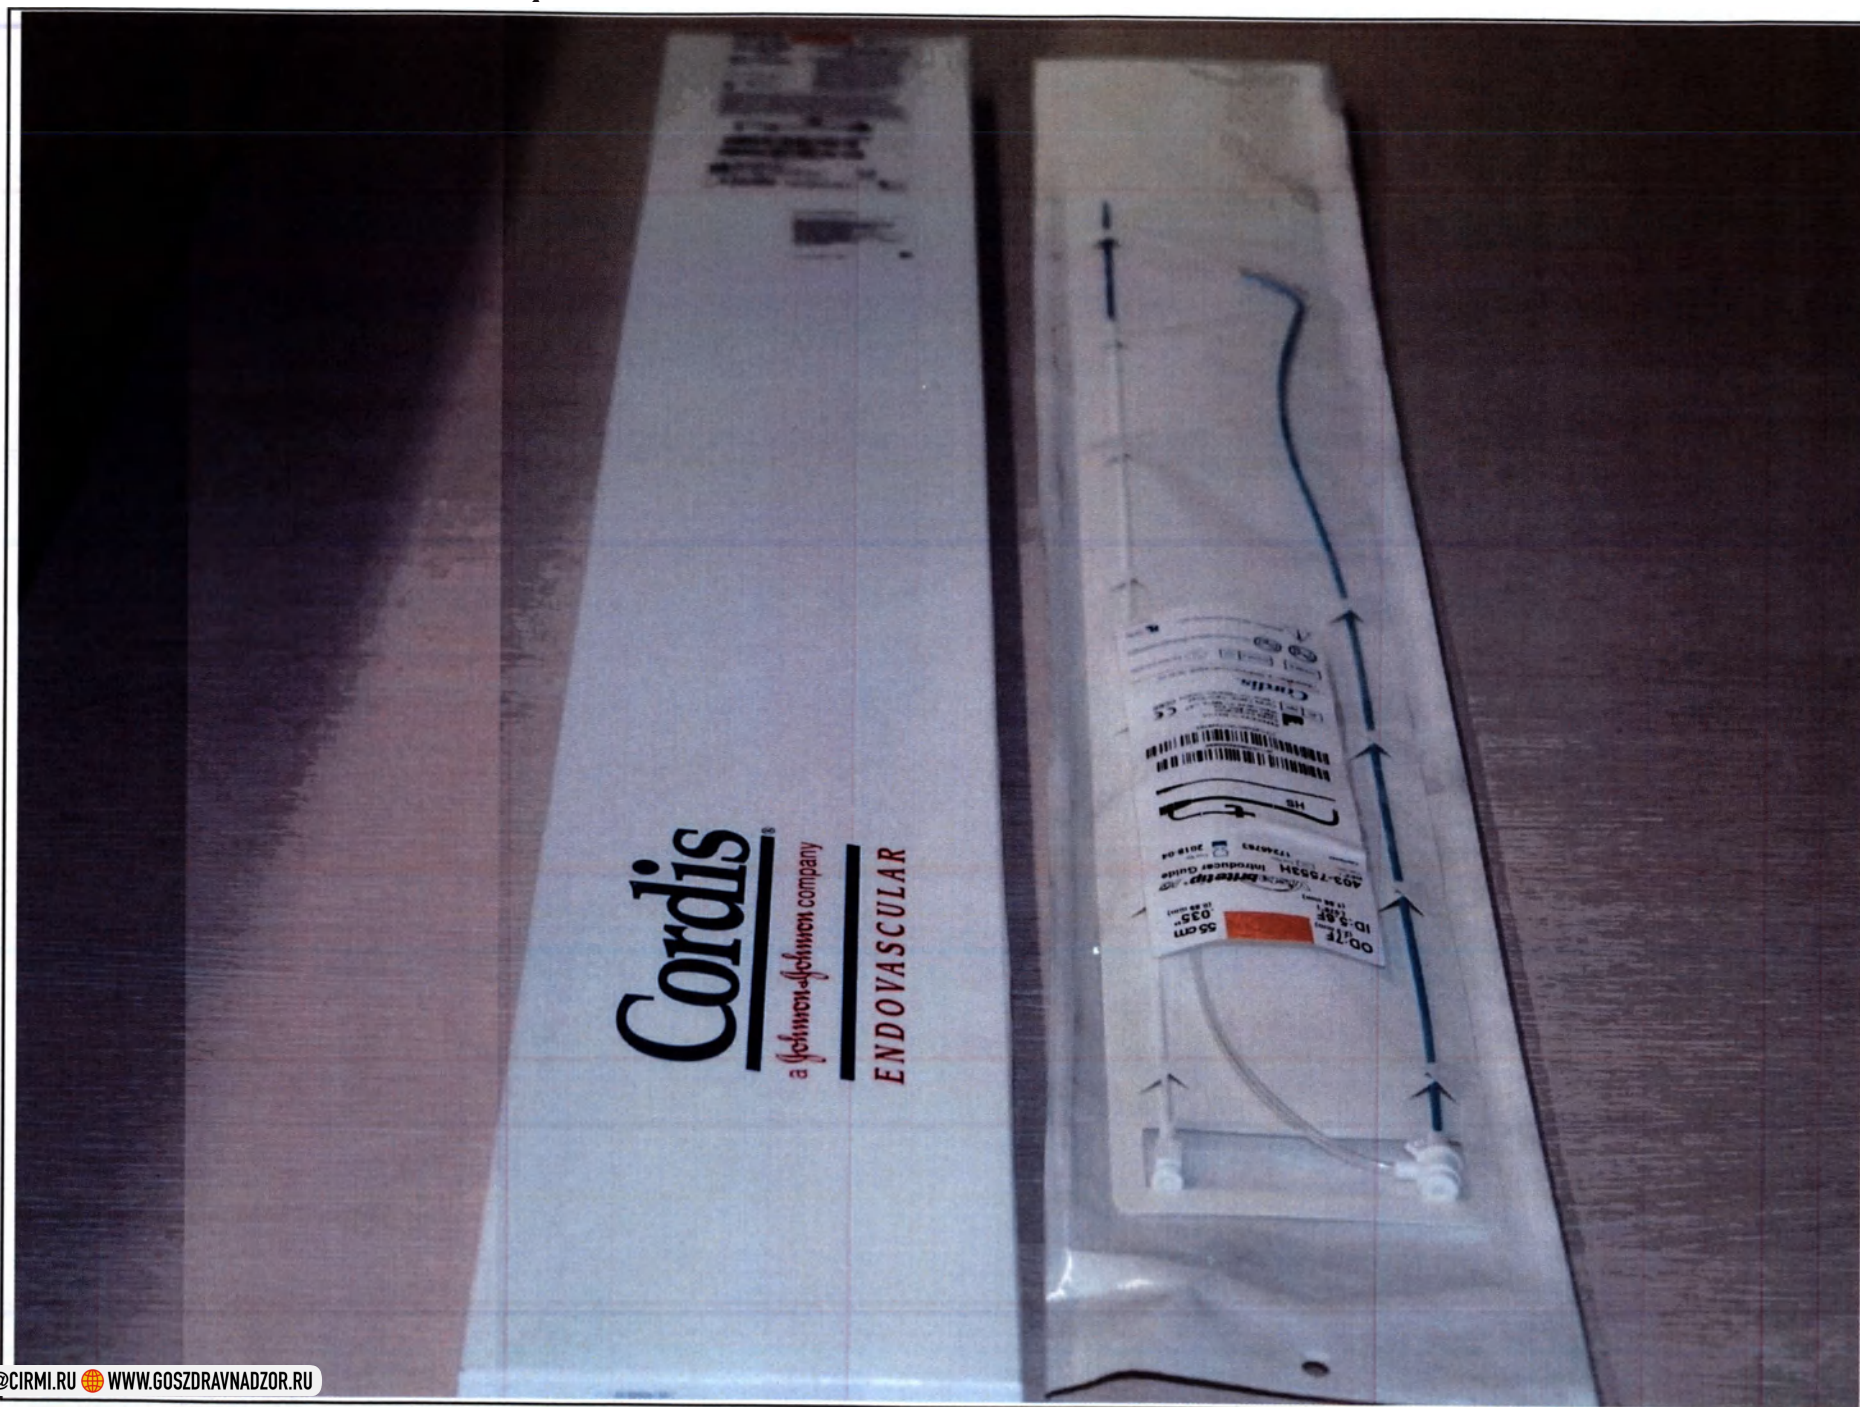



Катетер проводниковый

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°.

Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не использовать после истечения срока хранения.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Cordis Corporation, USA.

Импортер: ООО "Джонсон&Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3272

Орган сертификации: -



Артикул 4037553H 15286





EC REP Cordis Cashel, Cahir Road
Cashel, Co Tipperary, Ireland


Устройства для рентгеноваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер проводниковый


Область применения: В медицине
Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике
Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777
Reg. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 466C210F 16340

**Sample ONLY.
Not For Resale!**
**Бесплатный образец.
Не для продажи!**

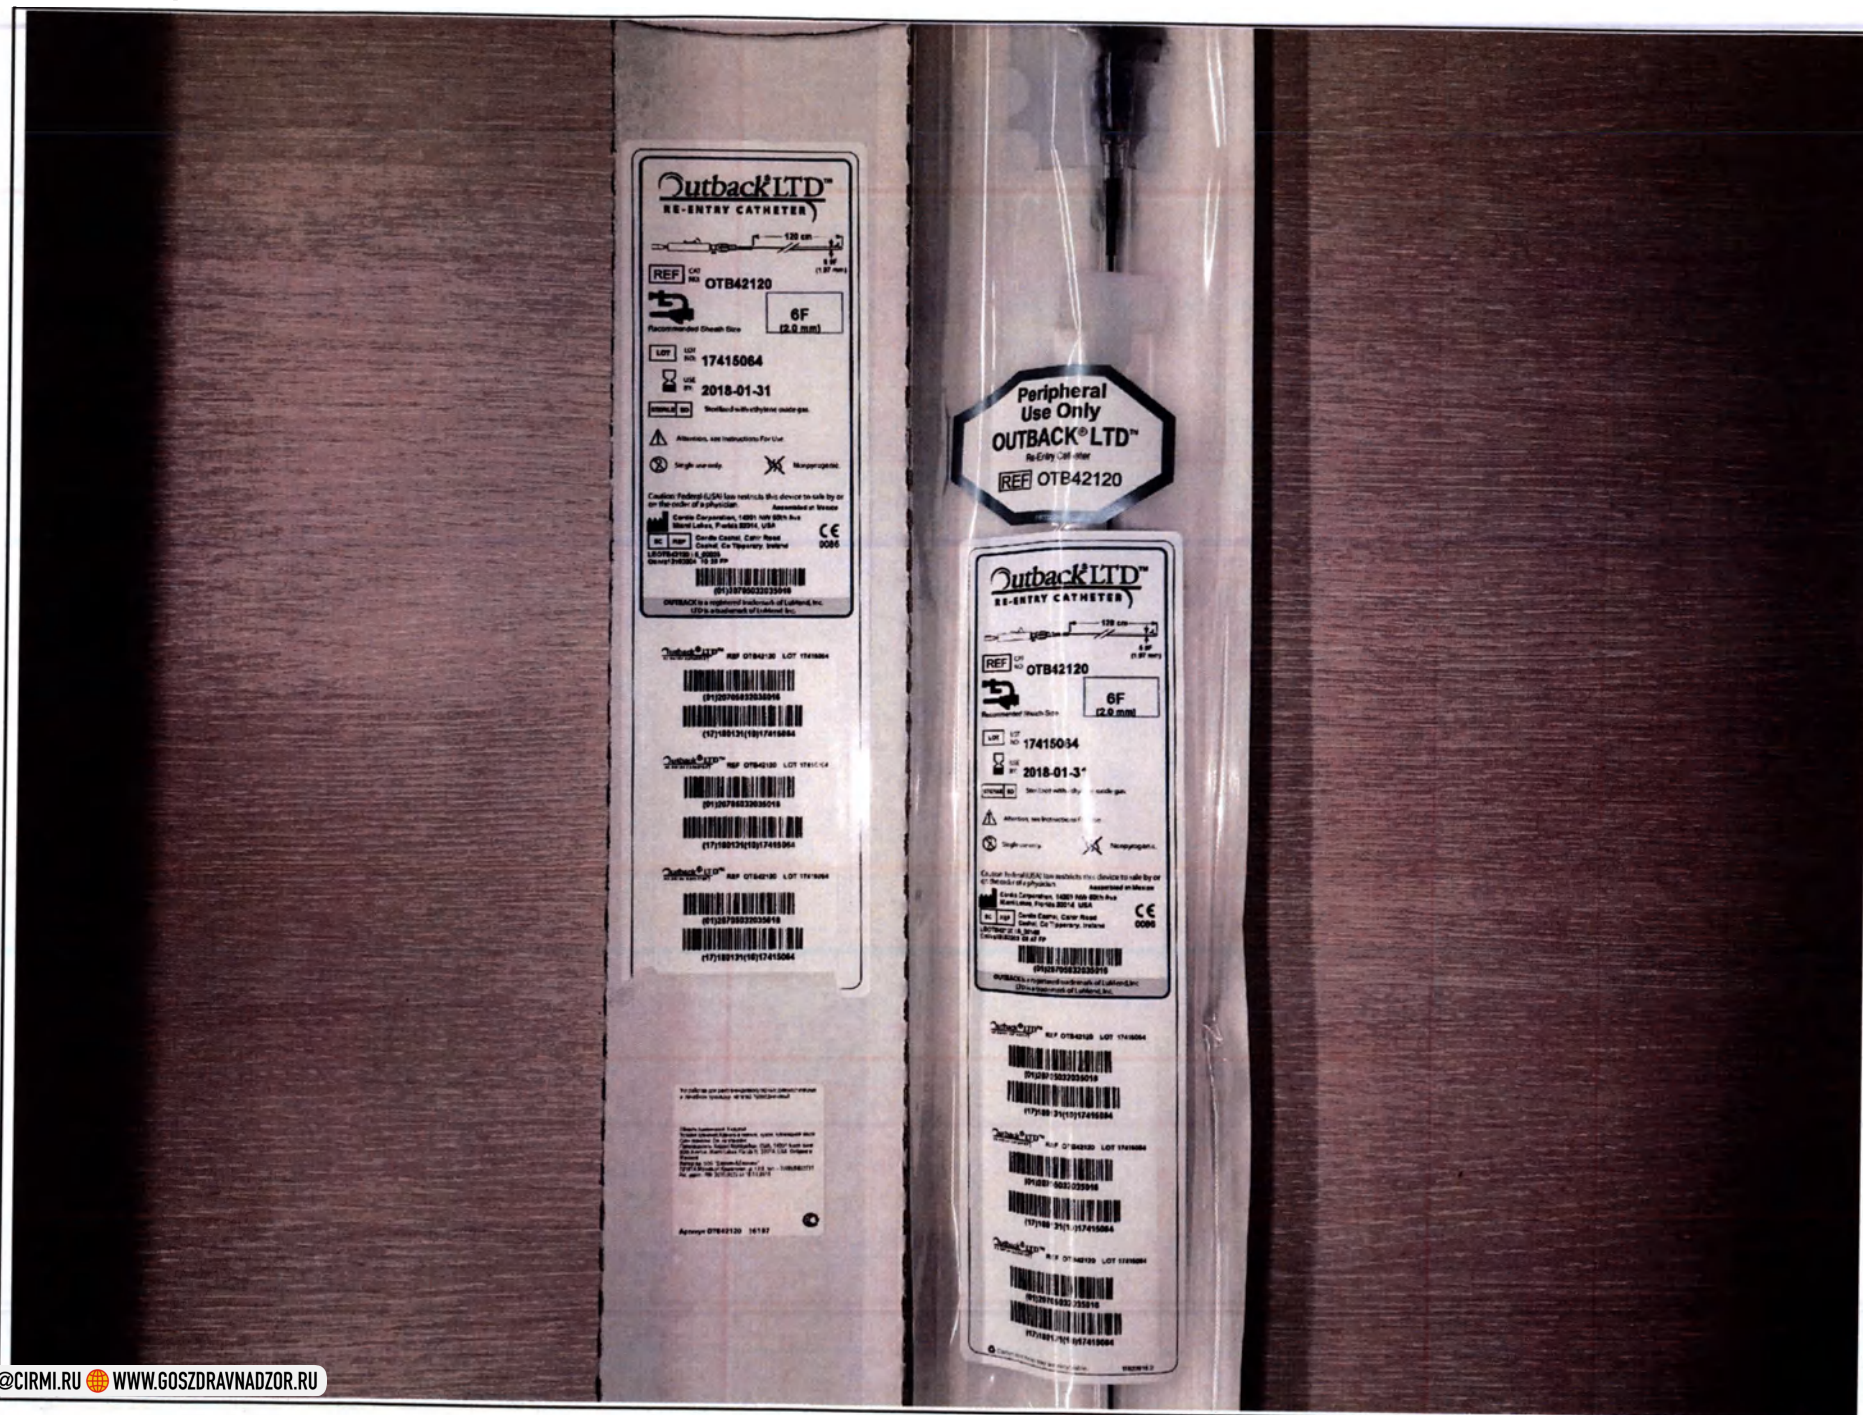

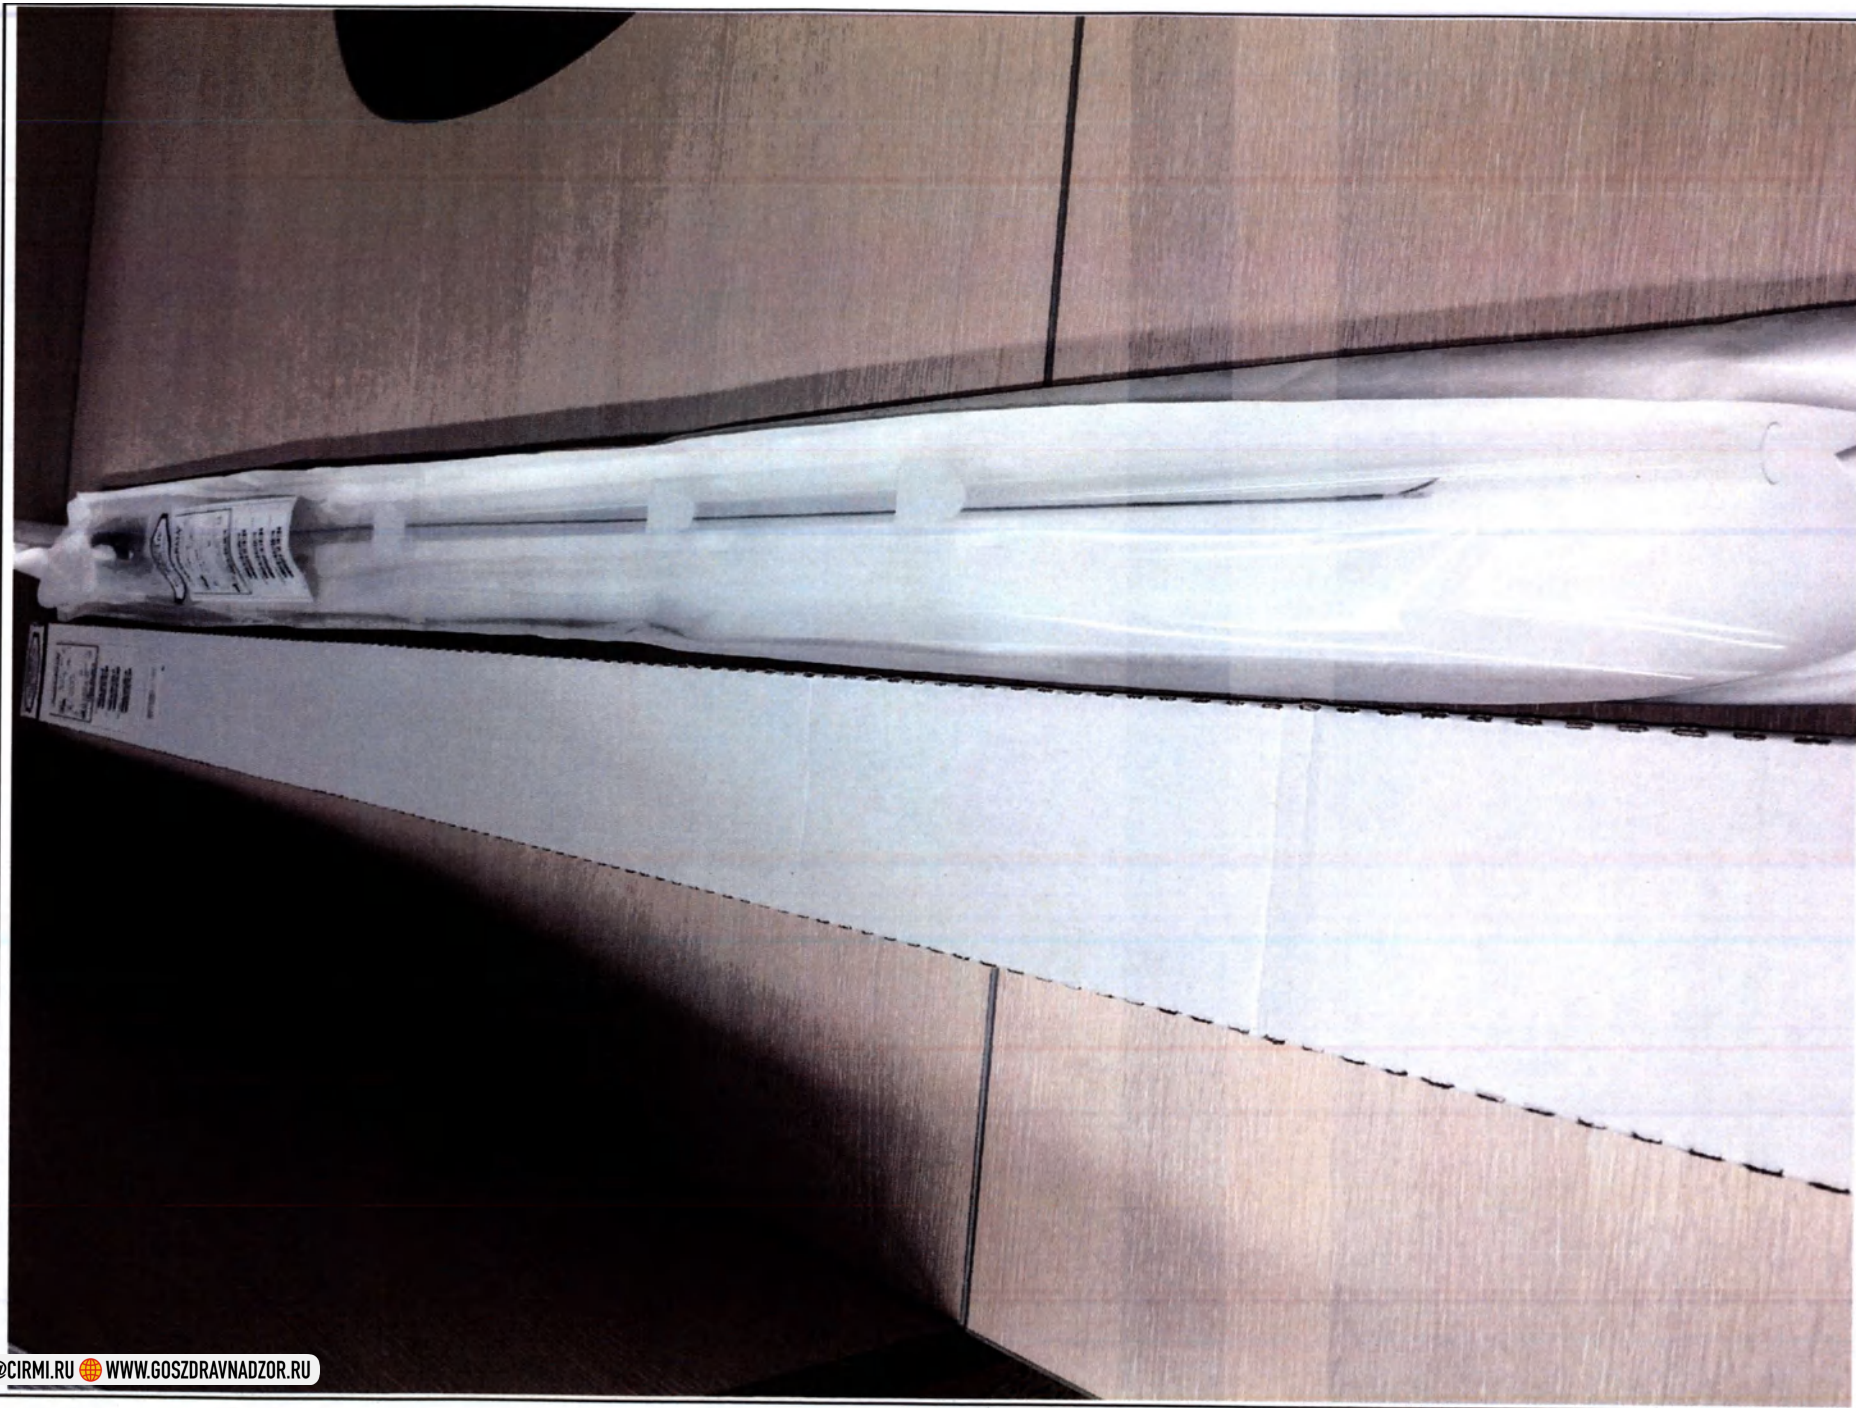

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: катетер проводниковый

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике


Импортер: ООО "Джонсон&Джонсон"


121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495) 5667777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул ОТВ42120 16197

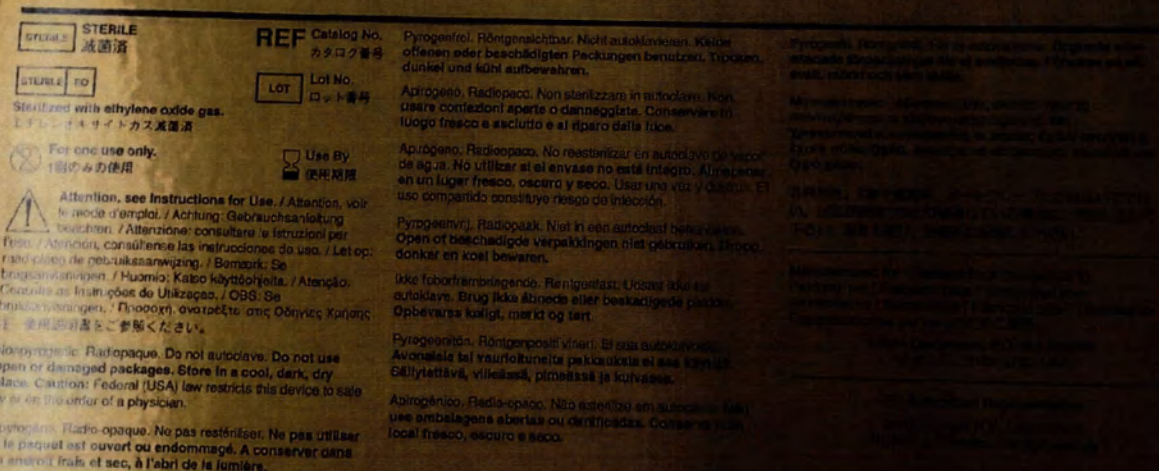

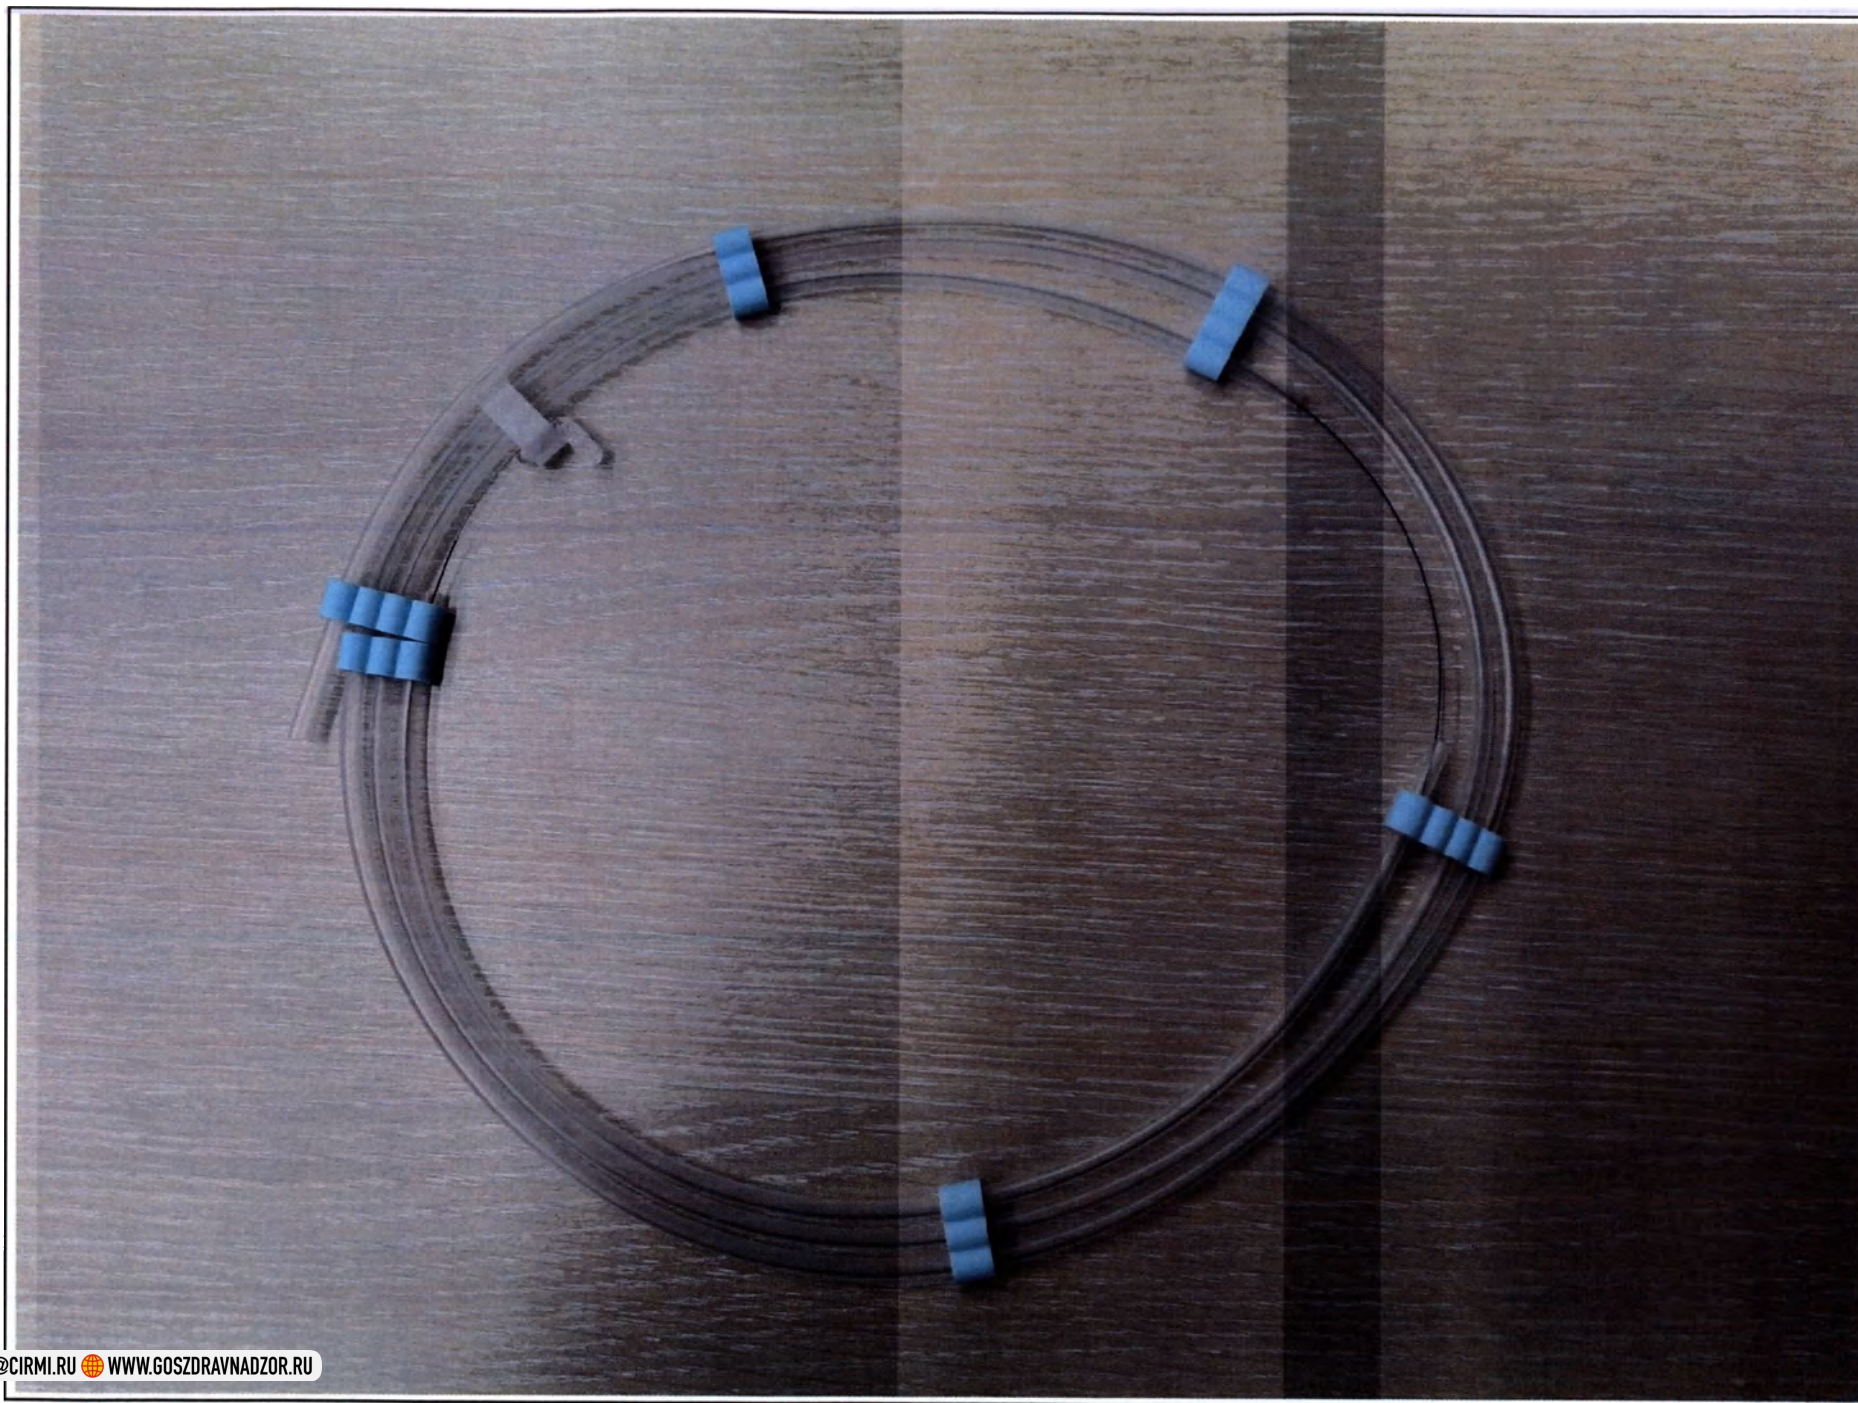

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"


121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015




Артикул 595J014 16266

Проводники ATW Marker wire

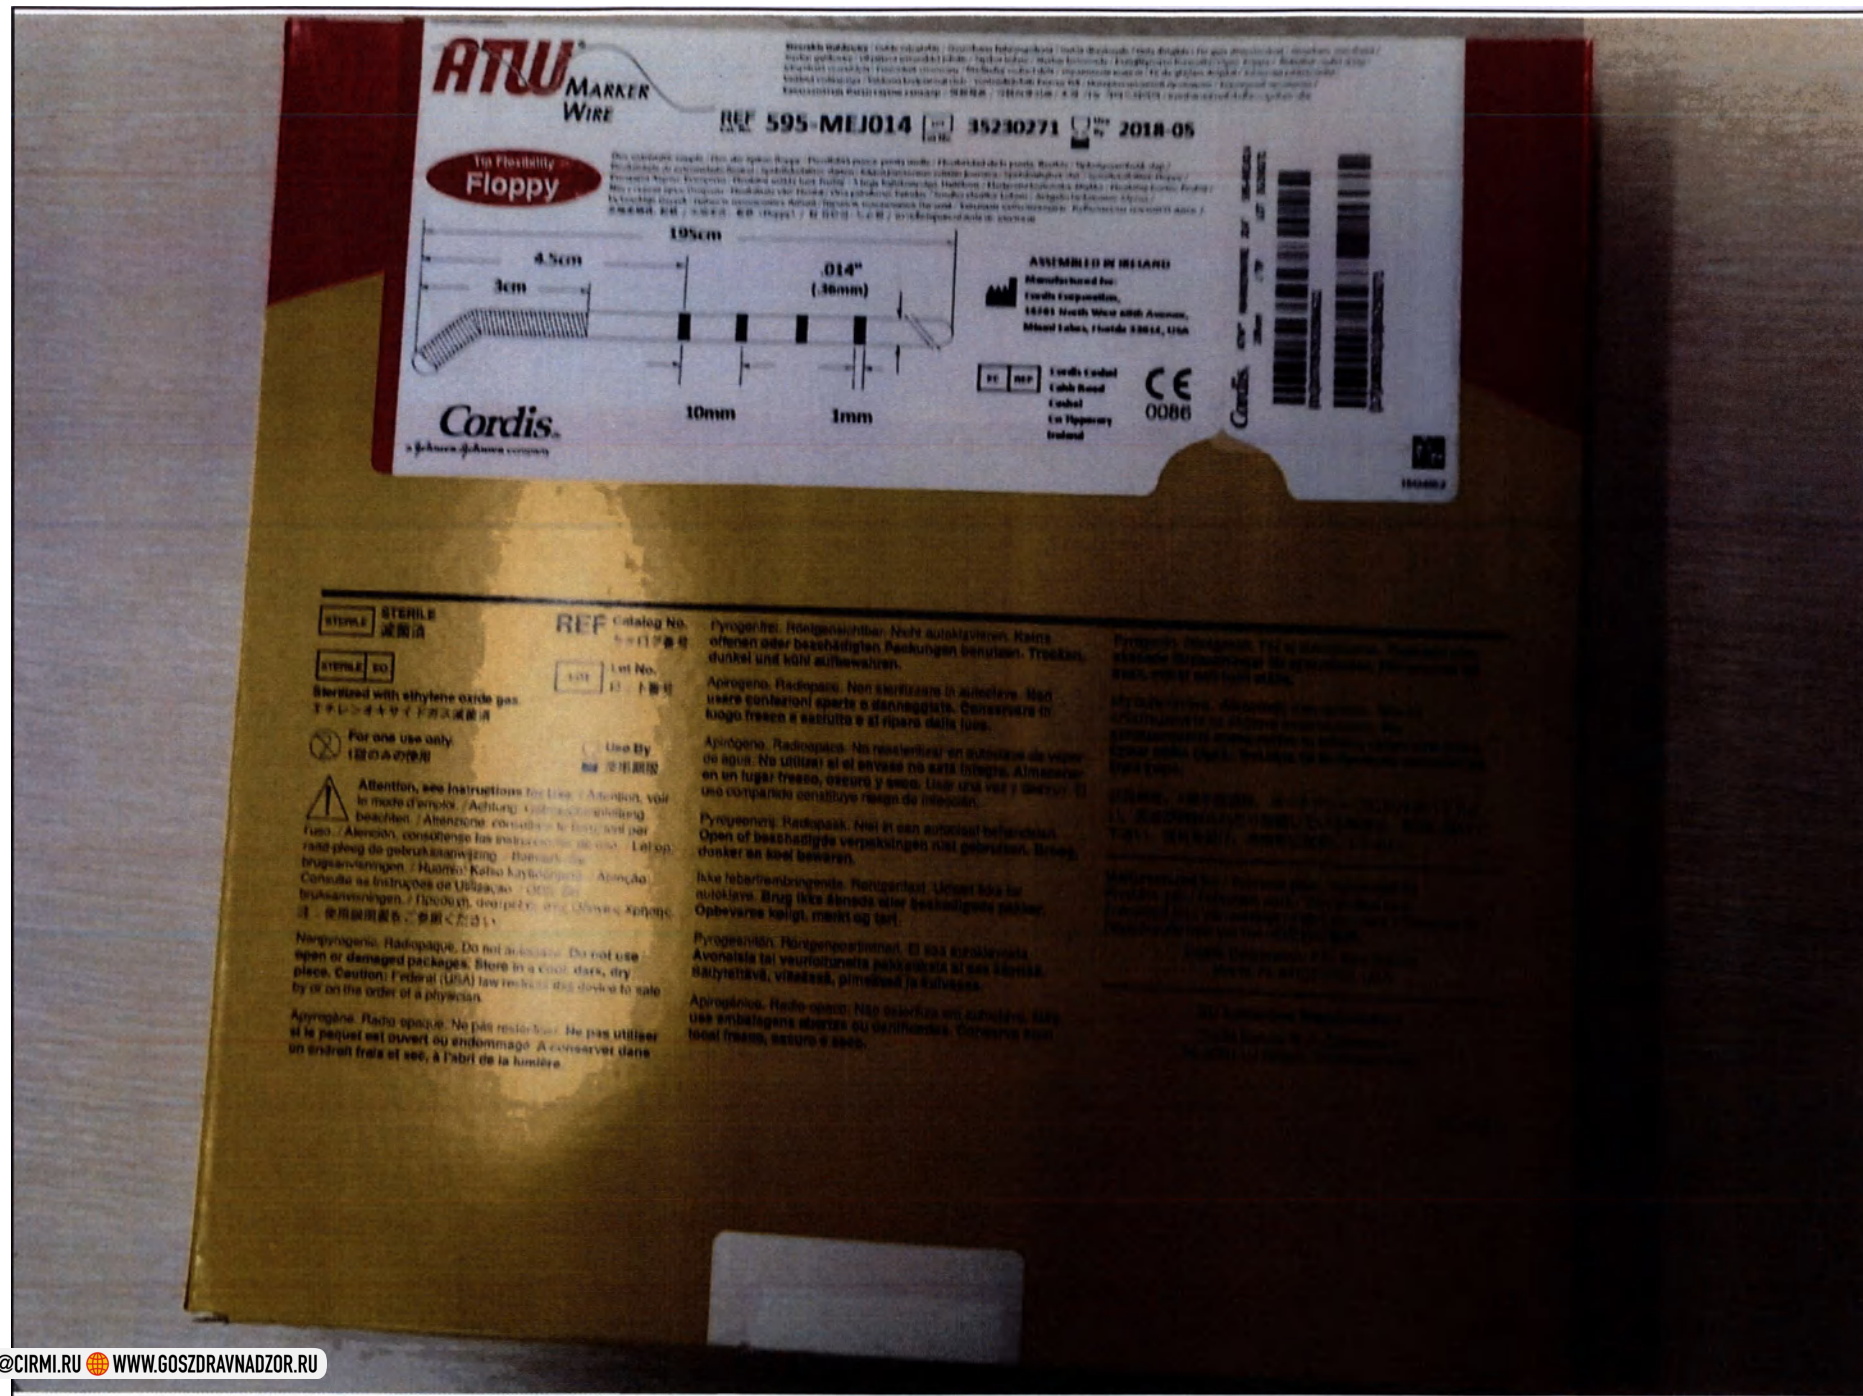

Проводники ATW Marker wire

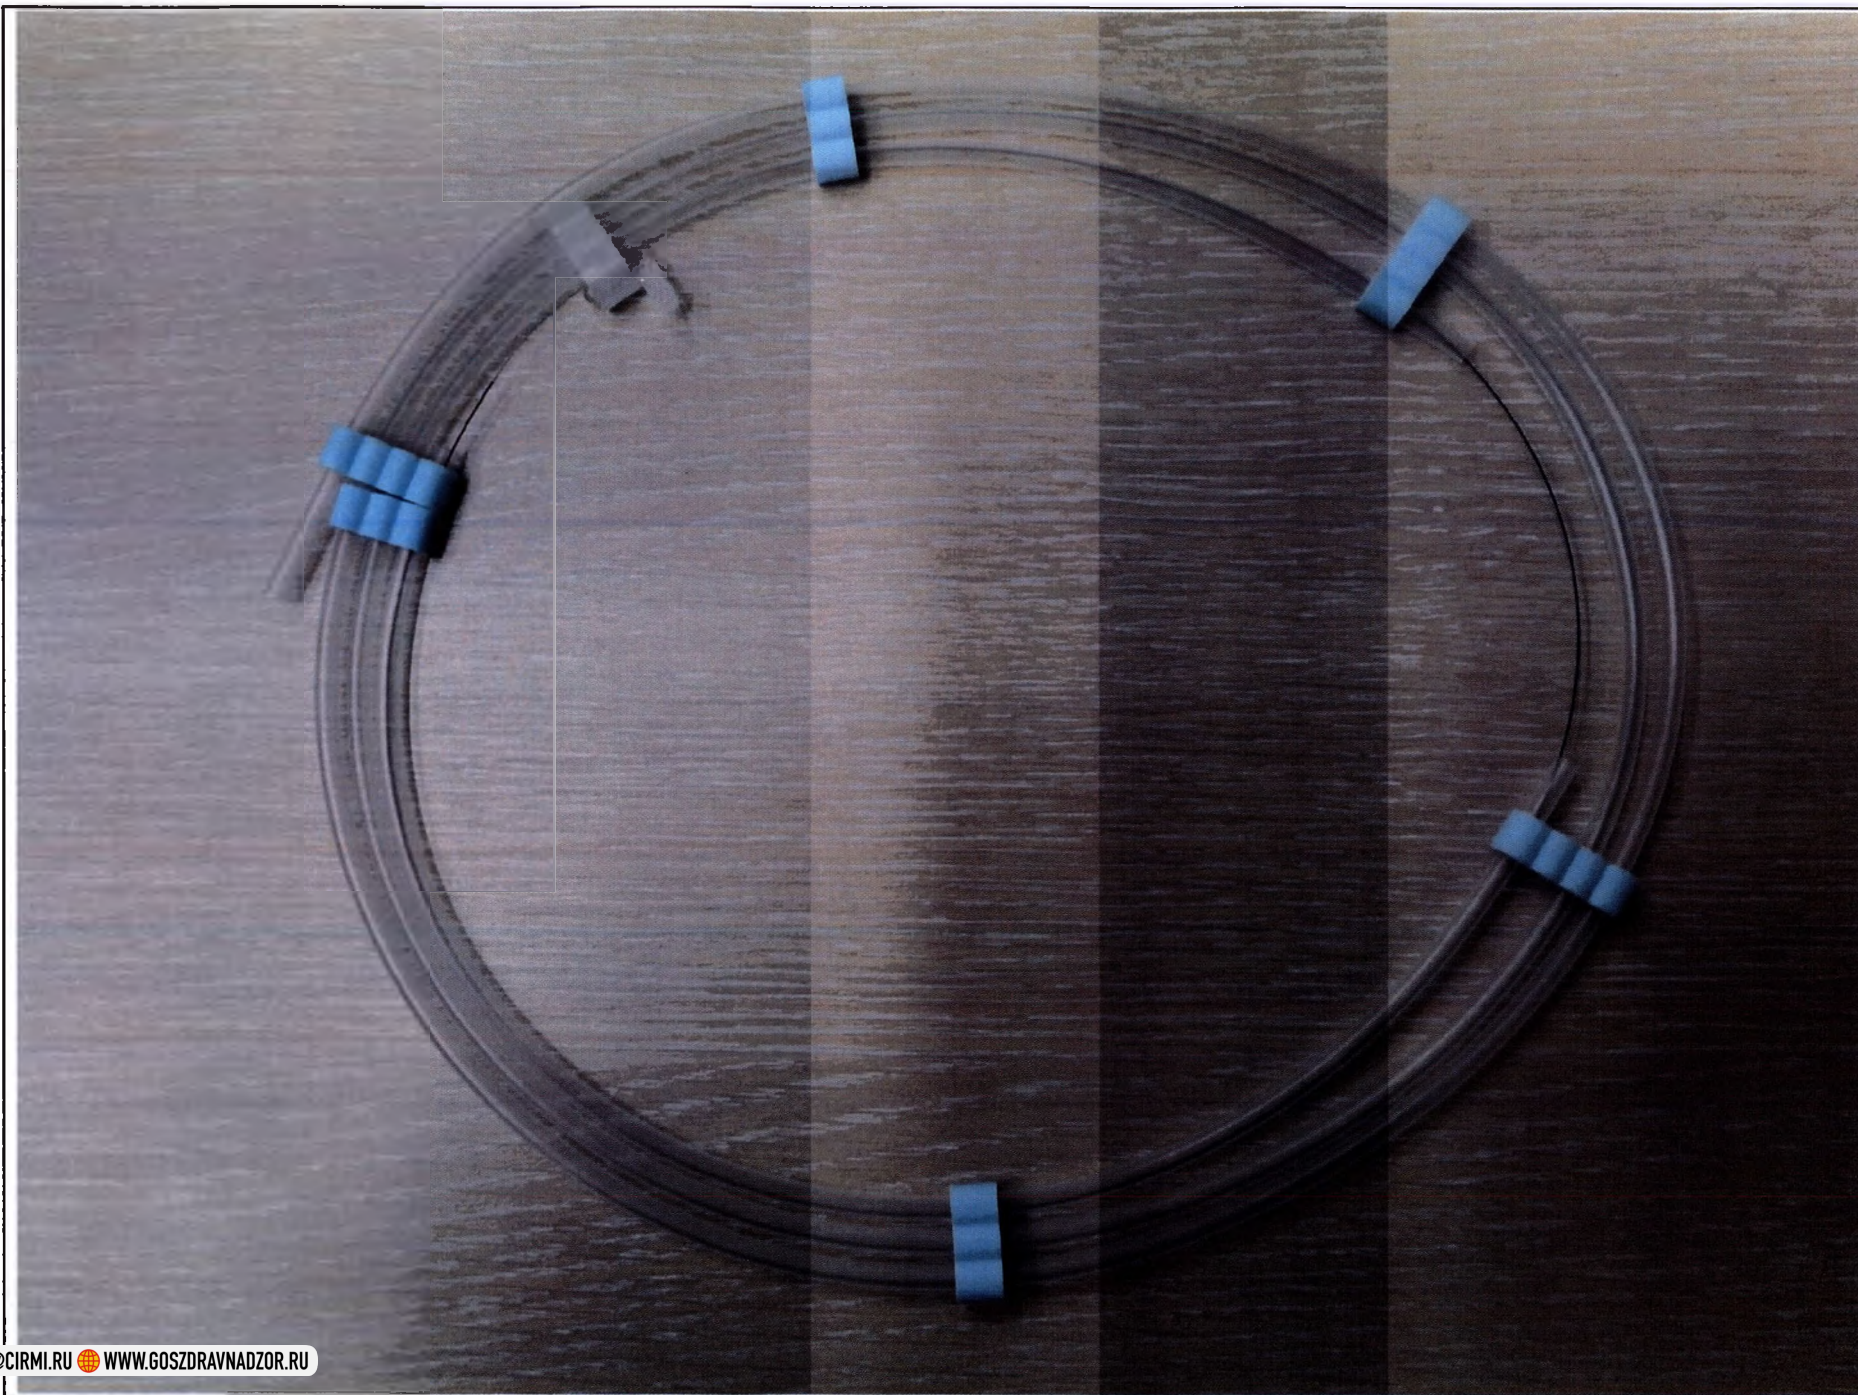

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник

Область применения: В медицине
Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA
Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777
Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 595МЕJ014 16266

Cordis
a Johnson & Johnson company


REF
Cat. No. **502-526**

LOT Lot No. **35228557**

 Use By **2018-12**

5 EMERALD™ Guldowires

5 GUIDER EMERALD / 5 EMERALD Führergründlitz / 5 GUIDER EMERALD / 5 GUIDER EMERALD / 5 EMERALD Fluo-guider
5 EMERALD -voordrader / 5 EMERALD guidewires / 5 EMERALD -beelden (3 kpl) / 5 EMERALD -leders / 5 EMERALD -taakbeelden
5 Katschovnikova Školjara EMERALD / 5 vodichik drat EMERALD / 5 EMERALD vasserdichte / 5 prouzdachnikov EMERALD
5 vodichik dratov EMERALD / 5 Fine de ghidare EMERALD / 5 EMERALD -beelden (3 kpl) / 5 EMERALD -beelden (3 kpl)
5 „EMERALD“ kreiplasmosio vilos / 5 EMERALD Kárvut 70i / 5 пружина EMERALD / 5 EMERALD -beelden (3 kpl)
5 EMERALD 燈形導引線 / 5 EMERALD 70i / 5 пружина EMERALD / 5 EMERALD 燈形導引線

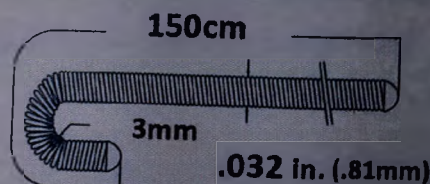

Coating / Revêtement / Beschichtung / Rivestimento / Recubrimiento / Revestimento / Dekking / Belagring / Placering / Bestrijking
Sileggi / Einbaulage / Potali / Bevonat / Powłoki / Povlaklar / Invelp / Kase / Pakkijung / Dering / Kaplams / Kapsurung / 包
造 / 包造 / 包造

PTFE / PTFE / PTFE / PTFE / Polytetrafluoroetileno / PTFE (Polytetrafluoroetilen) / PTFE / PTFE
(Polytetrafluoroethylen) / PTFE / PTFE / PTFE / PTFE (Πολυτετραφθοροαιθυλ ην) / PTFE / PTFE / PTFE /
PTFE / PTFE / PTFE / PTFE / PTFE / PTFE (тефлон / 聚四氟乙烯(四氟) / 聚四氟乙烯 (PTFE) / PTFE /
PTFE

[illegible]

Fixed / Fixe / Fest / Fissa / Fija / Fijo / Vast / Fikseet / Kinnak / Fast / Fiksari / Σταθερό / Pevný / Rögzített /
/ Ustáleno / Pevný / Fix / Fikseeritud / Fikseta / Fiksanta / Sahit / Фиксированный / 固定 / 固定 / 고정 /
ແກ່ງຄາມບໍ່ປ່ຽນ

Description / Description / Beschreibung / Description / Description / Description / Beschreibung / Beschreibung / Nomens / Beskrivning /
 Rekrutering / Rekrutering / Rekrutering / Rekrutering / Rekrutering / Rekrutering / Rekrutering / Rekrutering / Rekrutering / Rekrutering /
 招聘 / 招聘 / 招聘 / 招聘 / 招聘 / 招聘 / 招聘 / 招聘 / 招聘 / 招聘 /

Standard / Standard / Standard / Standard / Estándar / Standard / Standaard / Standard / Vakió / Standard
/ Standard / Κανονικό / Standardni / Standard / Standardny / Standard / Tavaline / Standarta /
Standartinis / Standart / Стандартный / 표준 / 標準 / 표준 / मानक

Standard J - Tip



(01)20705032055182


EMERALD™ 502-526 • 5622857 • 2018-12



(17)181231(10)35228557

ASSEMBLED IN IRELAND

 Manufactured for:
Cordis Corporation,
14201 North West 60th Avenue,
Miami Lakes, Florida 33014, USA

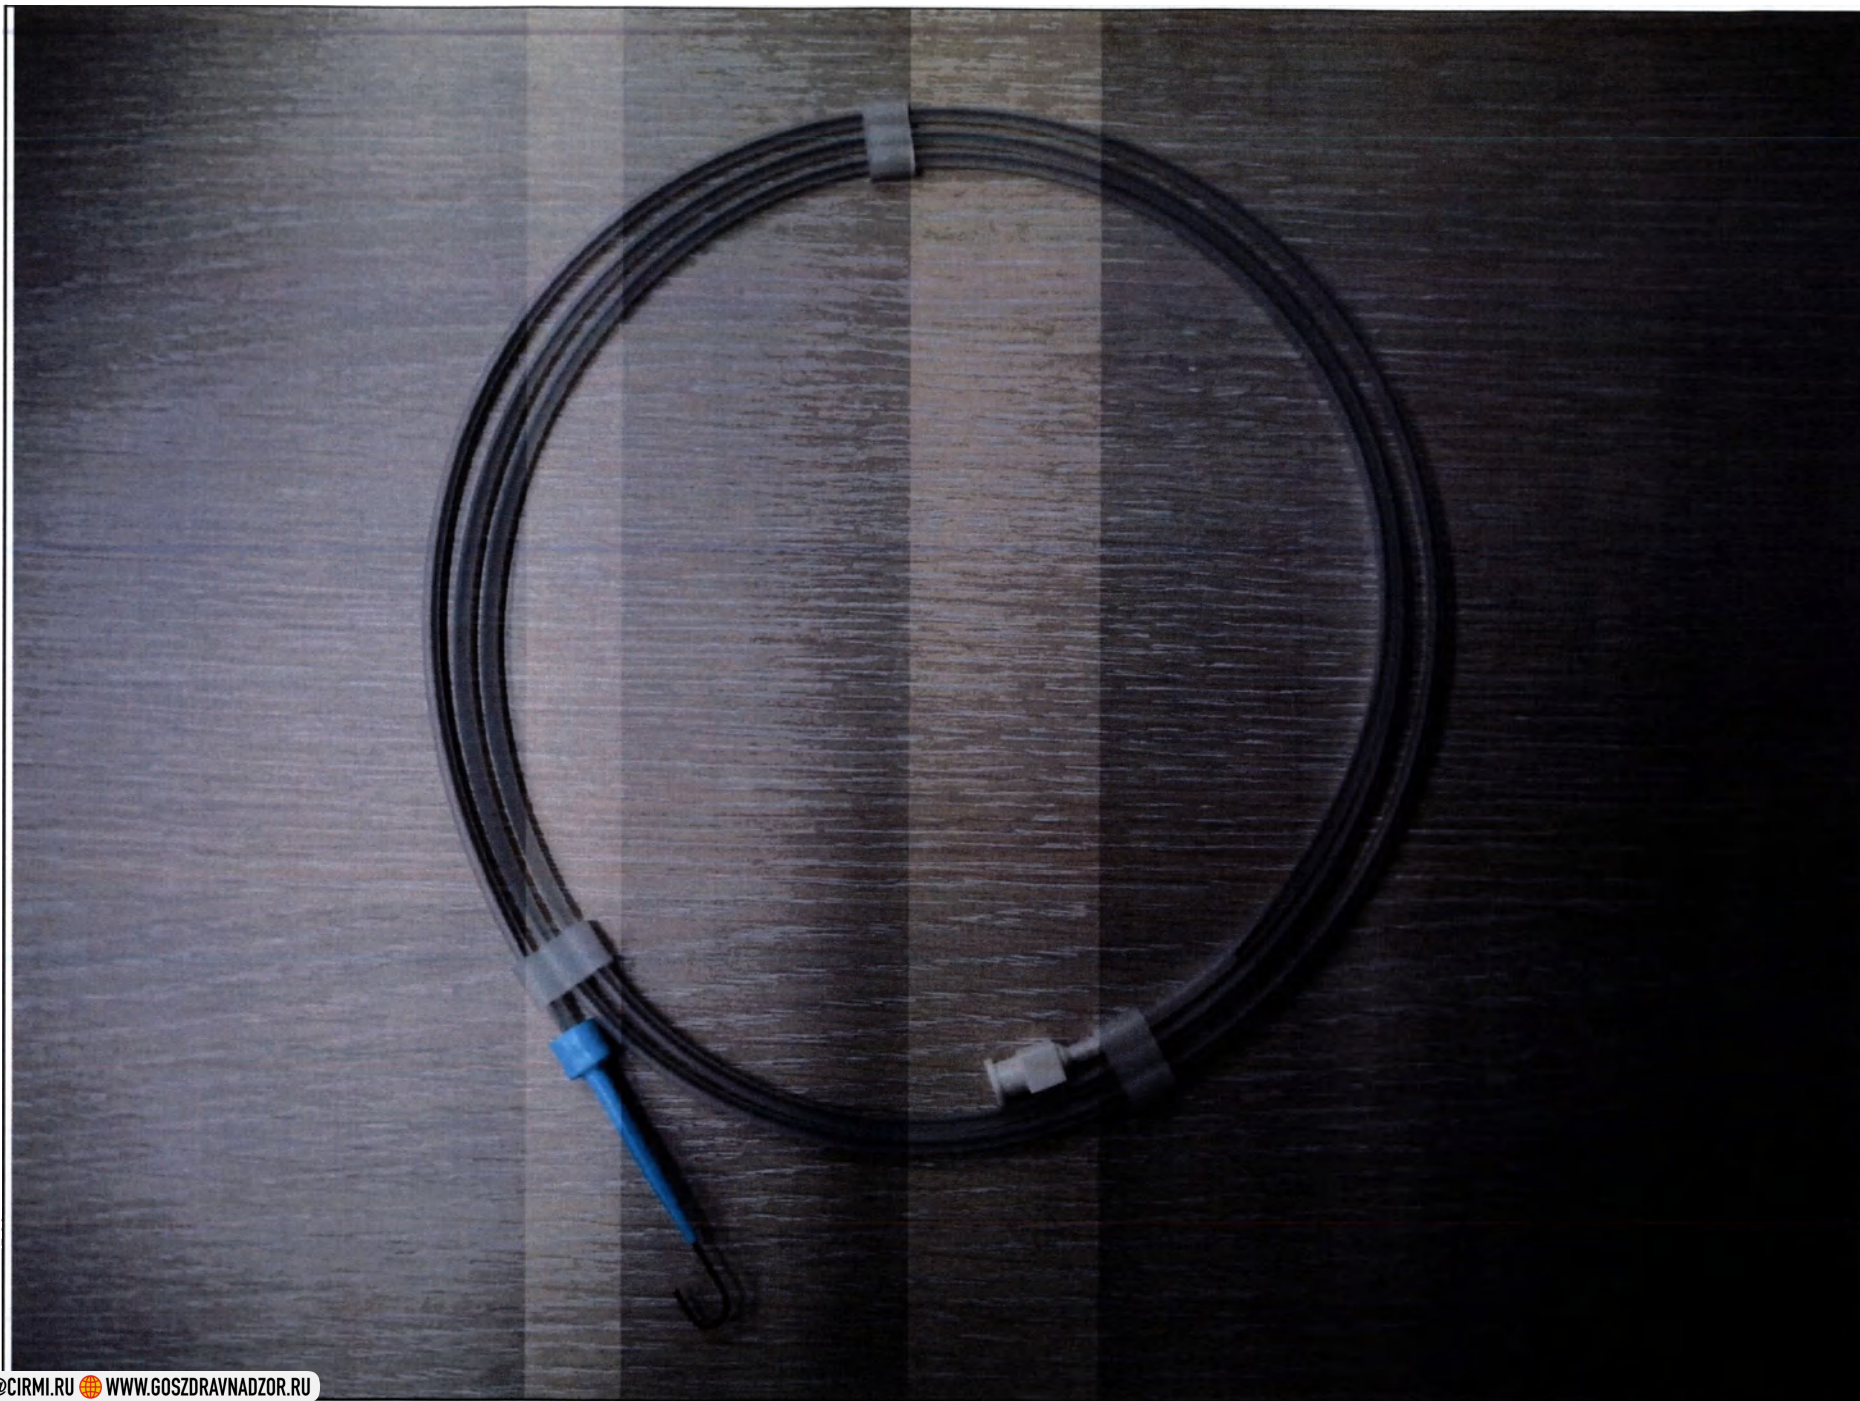



ASSEMBLED IN U.S.A.
Manufactured for:
Cordis Corporation,
14201 North West
Miami Lakes, Florida

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
 и лечебных процедур: проводник

Область применения: В медицине
 Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте
 Срок годности: См. на упаковке
 Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
 60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014. Собрано в Lake
 Region Medical Ltd., Ирландия
 Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон"
 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777
 Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 502526 16306



Проводник

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°.

Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не использовать после истечения срока хранения.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: См. на упаковке

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 503452 16211

REFLEX™

Cordis
Johnson & Johnson Company

5 Steerable Guidewires with SLX™ Coating

5 guiden orientierbar & steuerbar, SLX / 5 Steuerbare Führungsdrahte mit SLX-Beschichtung

5 guide directional & steerable SLX / 5 guias direcionais com revestimento de SLX

5 stuurbare voerdrahten met SLX -dekking / 5 stuurbare geleidewires met SLX-bekleding

5 kápt eligetváros járódrót, jelkes SLX-sírnak / 5 flexi guía desdobrándose con revestimiento SLX

5 steyrbar indare smál SLX-beskyfning / 5 steyrbaririnn harrasteyrbarinná Tíggjarn og Erindurinn SLX

SLXコーティングステイヤーブルガイドワイヤ5本

ITEM: 502014B

LOT: 35229245

REF 502-014B

Lot No.

Exp. By

2019-02

REF 502-014B


Lot No.

(01)10706032064867

LOT: 35229245

(10)35229245

[illegible]

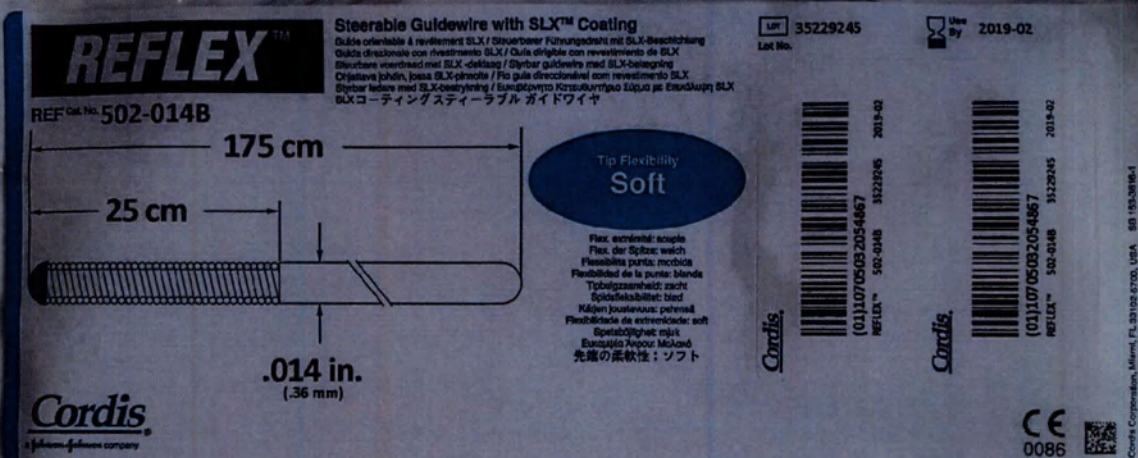

Проводник

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°.

Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не использовать после истечения срока хранения.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: См. на упаковке


Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.

Крылатская. д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 502014В 16357

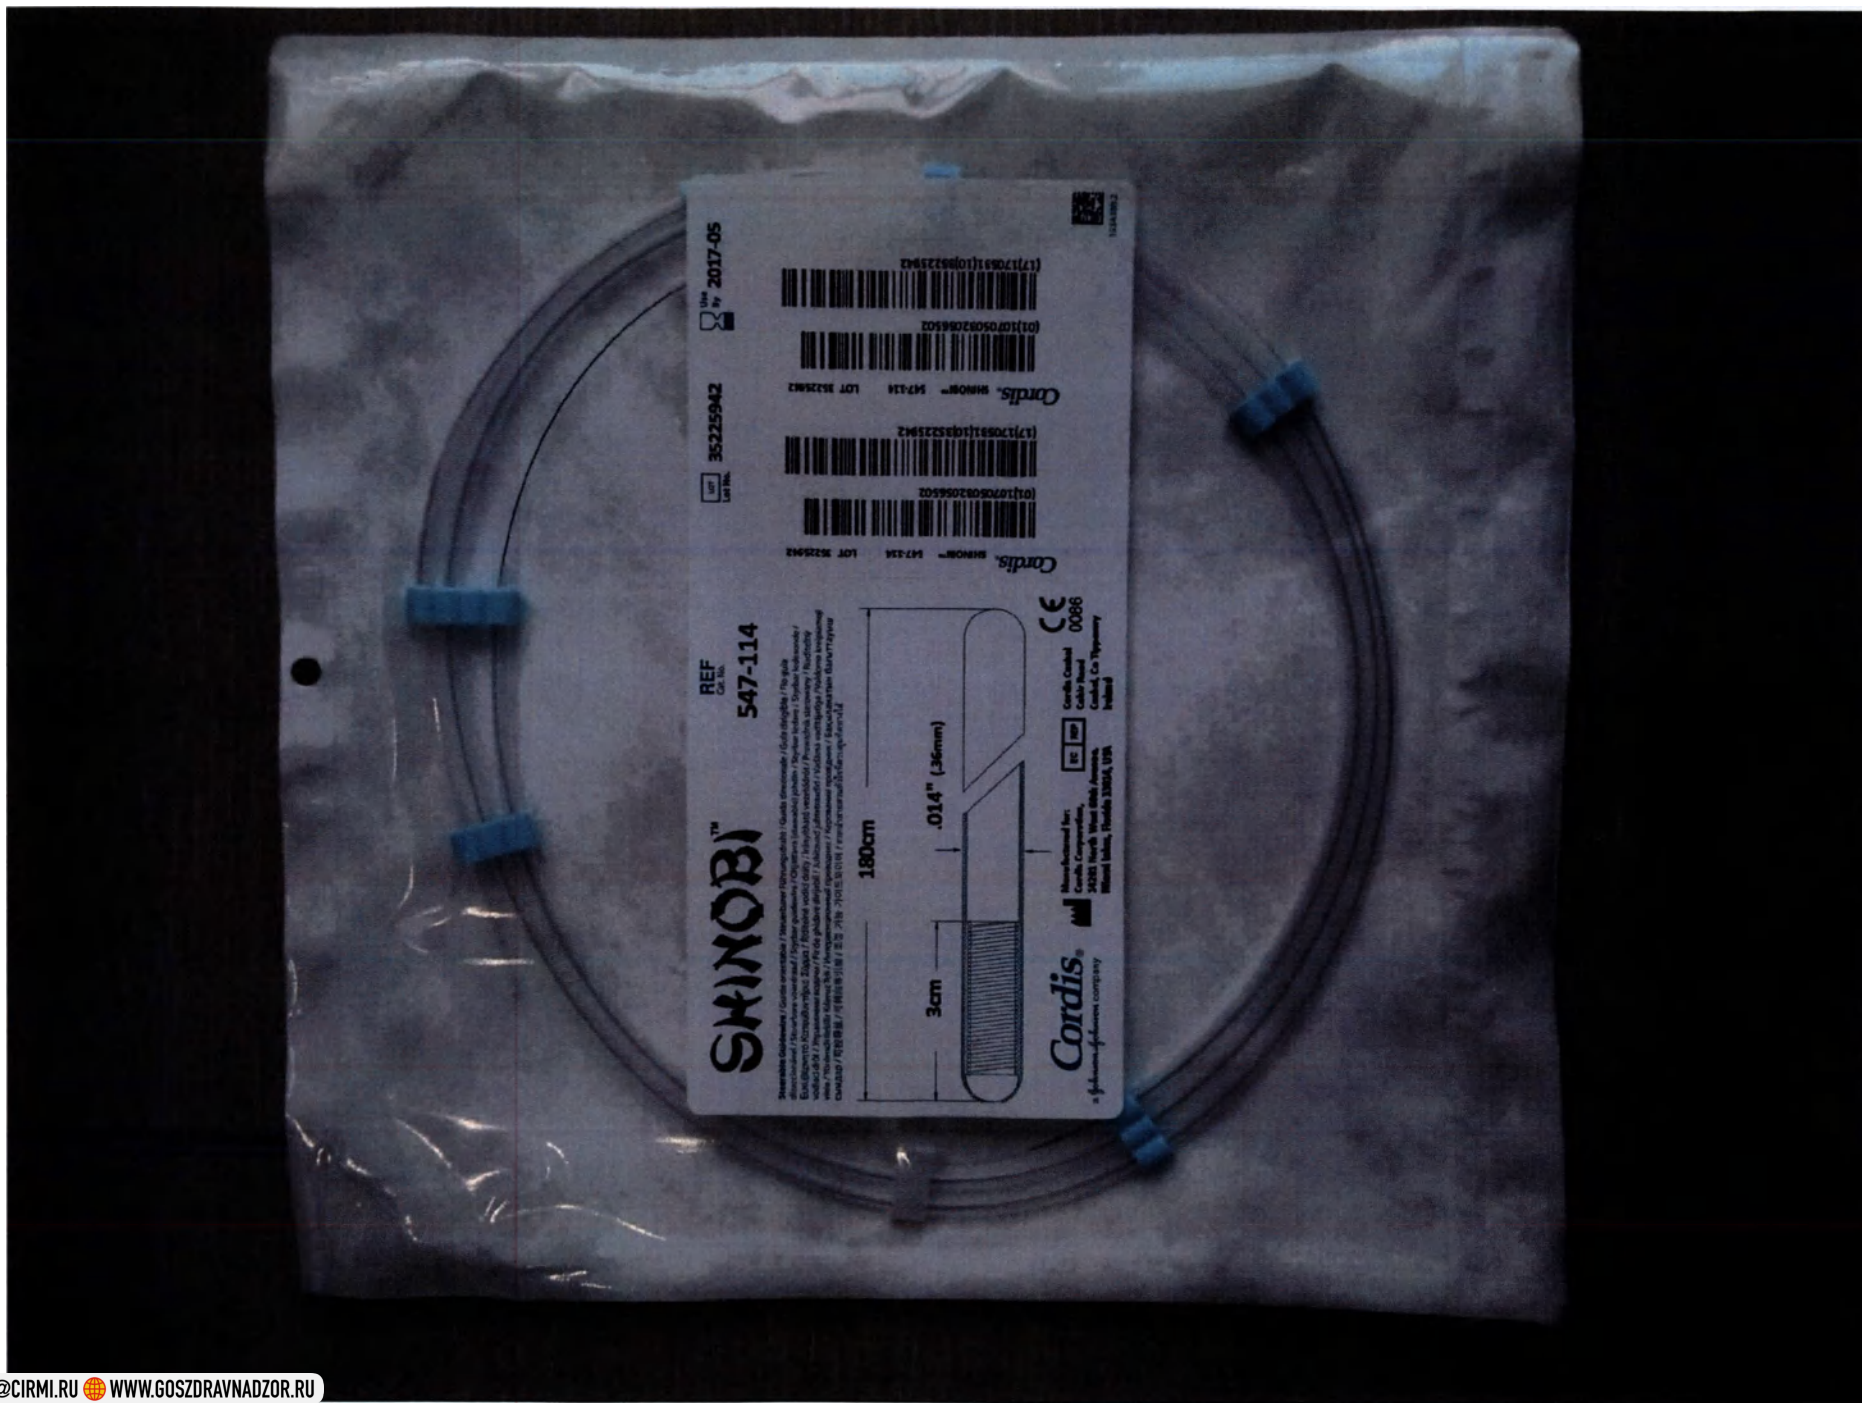

**Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник**

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 547214 16266

SHINOBI™ PLUS


REF 547-214

35228380

Use By 2017-12

Use By 2017-12

**Steenbare Guldewire / Guide orientable / Steuerbarer Führungsdraht / Guida direzionale / Guia dirigible / Pila guida
directionale / Steuerebare voerdraad / Styrbar guidewire / Objektivna steeribelná jehla / Styrbar ledare / Styrbar ledarsnorre /
Екстериторно катушковое зупя / Издрелни водци држ / Къришлхот везедърди / Проводник стегоран / Радистий
водил дръг / Управляемый провод / Pir de ghidare dirijabil / Zuhilvazd juhitevadiz / Vadmni vodnitsyaga / Valdema kreepamoj
vial / Yölenäitettävä Kääntä Teli / Управляемості провідники / Кероаний проводник / Бақылмағатин бағыттауыс
сымдар / 可程导线 / 可轉向導線 / 조경 가는 가이어드라이 / 可變向導線 / 可變向導線**

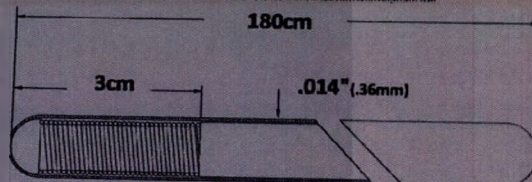

Cordis®
и Johnson-Johnson компания

ASSEMBLED IN IRELAND

 Manufactured for:
Cordis Corporation,
14281 North West 68th Avenue,
Miami Lakes, Florida 33014, USA

EC	
----	--

Cordis Catheters
Catheter Road
Cathol, Co. Tip
Ireland

CE
0086

0086

STERILE
滅菌液

STERILE	60
---------	----

Sterilized with ethylene oxide gas.
エチレンオキシドガス滅菌済

 For one use only.
1回のみ使用

 Attention, see Instructions for Use. / Attention, voir le mode d'emploi. / Achtung, Gebrauchsanleitung beachten. / Attenzione: consultare le Istruzioni per l'uso. / Atención, consulte las instrucciones de uso. / Let op: raadpleeg de gebruiksaanwijzing. / Bemærk: Se brugsanvisningen. / Huomio: Käyttöohjeita. / Alenção: Consulte as Instruções de Utilização. / OBS: Se brugsanvisningen. / Προσοχή, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσεως.

Nonpyrogenic. Radiopaque. Do not autoclave. Do not use open or damaged packages. Store in a cool, dark, dry place. Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Apyrogène. Radio-opaque. Ne pas stériliser. Ne pas utiliser si le paquet est ouvert ou endommagé. A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

REF Catalog No.

Lot No.
ロット番号

 **Use By**
使用期限

Pyrogenfrei. Röntgensichtbar. Nicht autoklavieren. Keine offenen oder beschädigten Packungen benutzen. Trocken, dunkel und kühl aufbewahren.

Apirogeno. Radiopaco. Non sterilizzare in autoclave. Non usare confezioni aperte o danneggiate. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce.

Apirógeno. Radioopaco. No reesterilizar en autoclave de vapor de agua. No utilizar si el envase no está íntegro. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y seco. Usar una vez y destruir. El uso compartido constituye riesgo de infección.

Pyrogeenvrij. Radiopaak. Niet in een autoclaaf behandelen.
Open of beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Droog,
donker en koel bewaren.


Ikke feberfrembringende. Røntgenfast. Udsæt ikke for autoklave. Brug ikke åbnede eller beskadigede pakker. Opbevares køligt, mørkt og tørt.

Pyrogeeniton. Röntgenpositiivinen. Ei saa autoklavoida.
Avonaisia tai vaurioituneita pakkauksia ei saa käyttää.
Säilytettävä, viileässä, pimeässä ja kuivassa.

Apirogénico. Radio-opaco. Não esterilize em autoclave. Não use embalagens abertas ou danificadas. Conserve num local fresco, escuro e seco.

Pyrogenfri. Röntgentät. Får ej autoklaveras. Öppnade eller skadade förpackningar får ej användas. Förvaras på ett svaltt, mörkt och torrt ställe.

Μη-μπετογόνο. Αδιαφορές στις εκκίνες. Μην το αποστειρώνετε σε κλίμα αποστείρωσης. Μη χρησιμοποιείτε συσκευασίες οι οποίες έχουν ανοίξει ή έχουν πάθει ζημιά. Θαλάσσι το σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό χώρο.

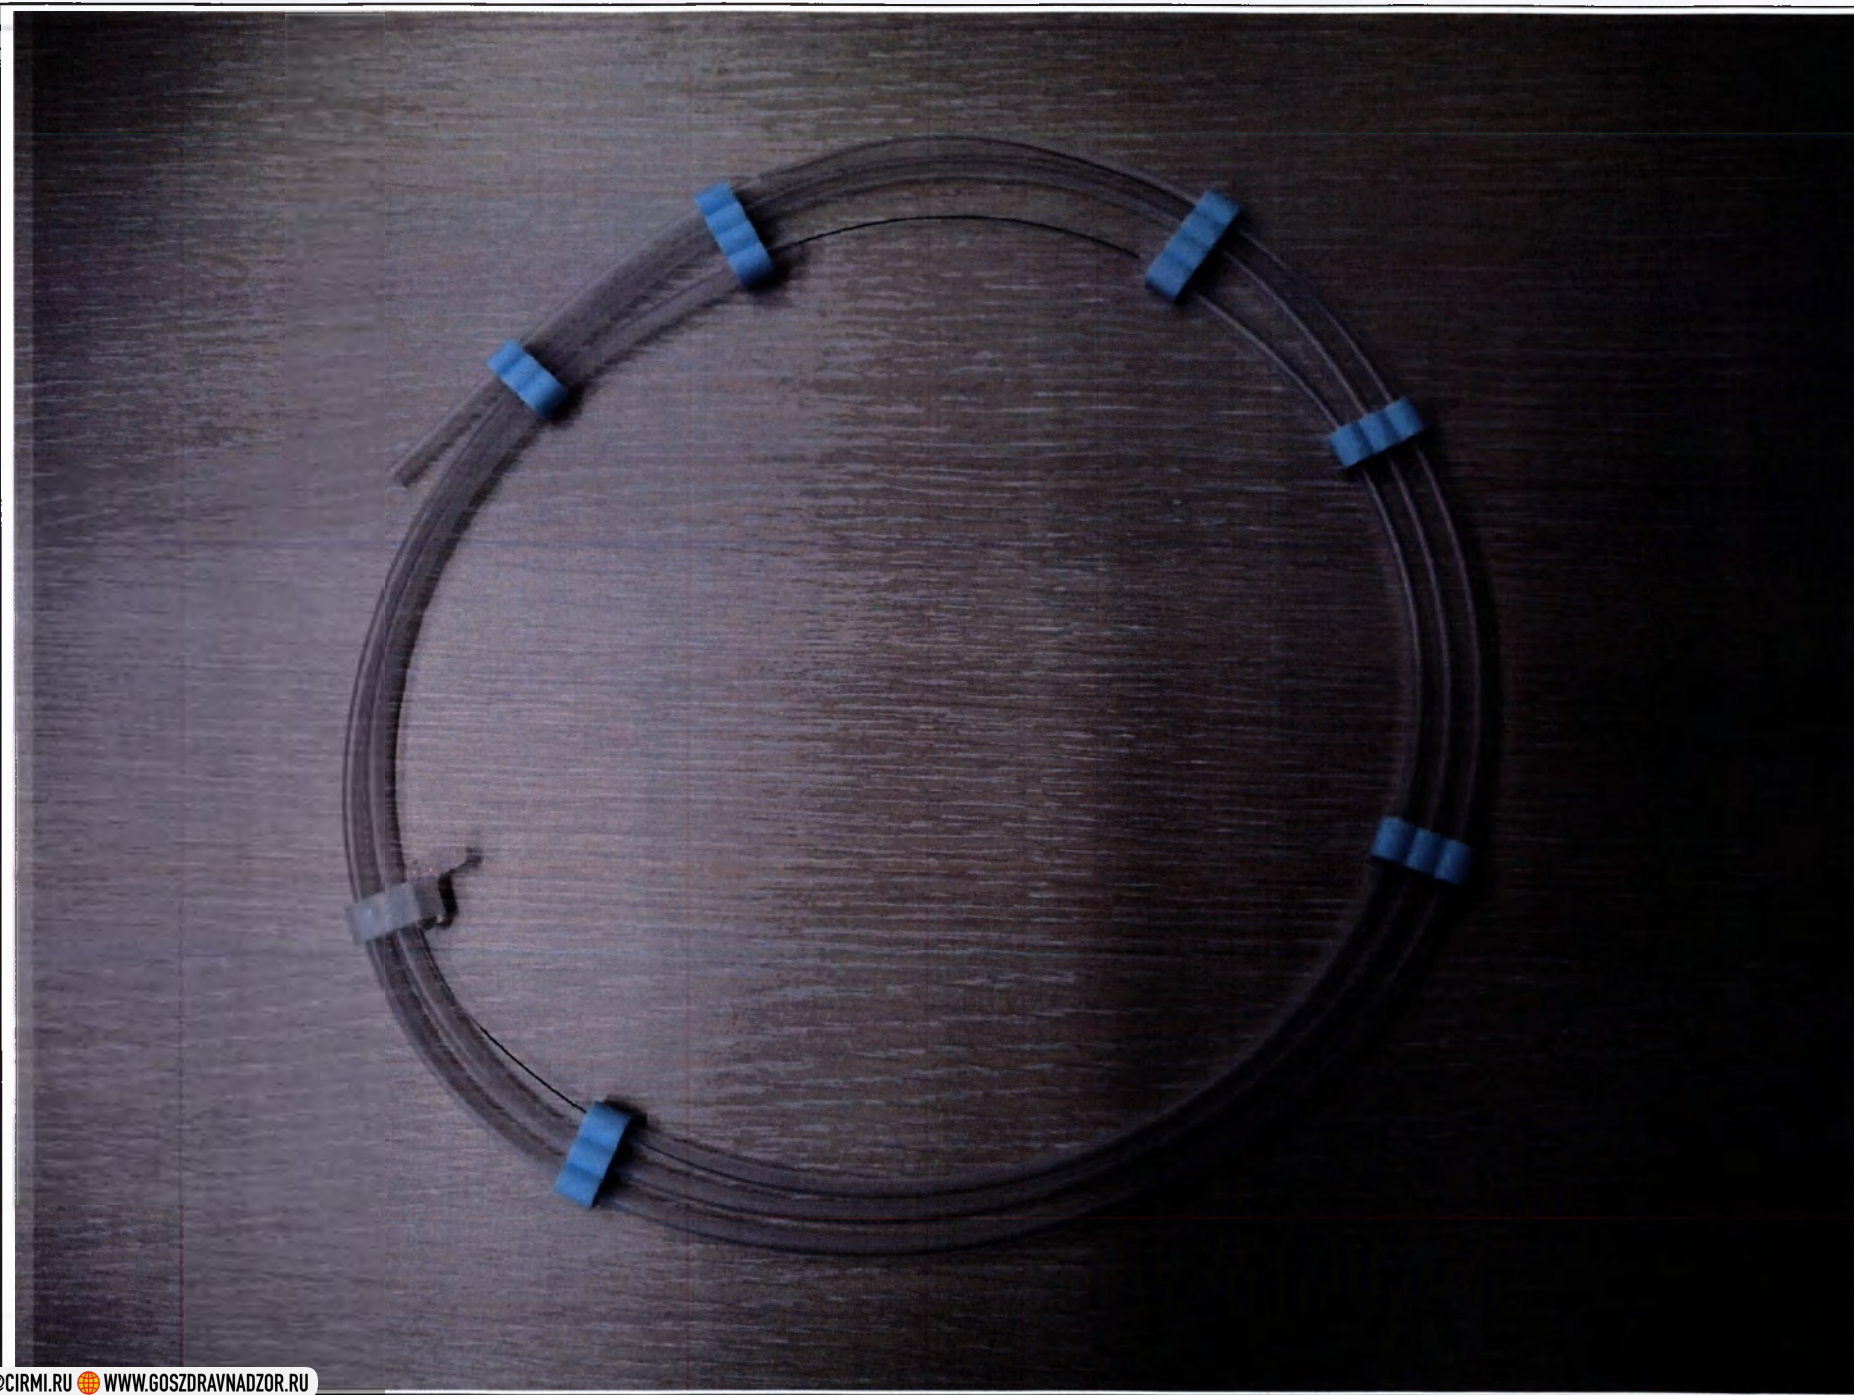

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник


Область применения: В медицине
Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA
Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777
Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 547214 16266



Проводники STABILIZER MARKER WIRE

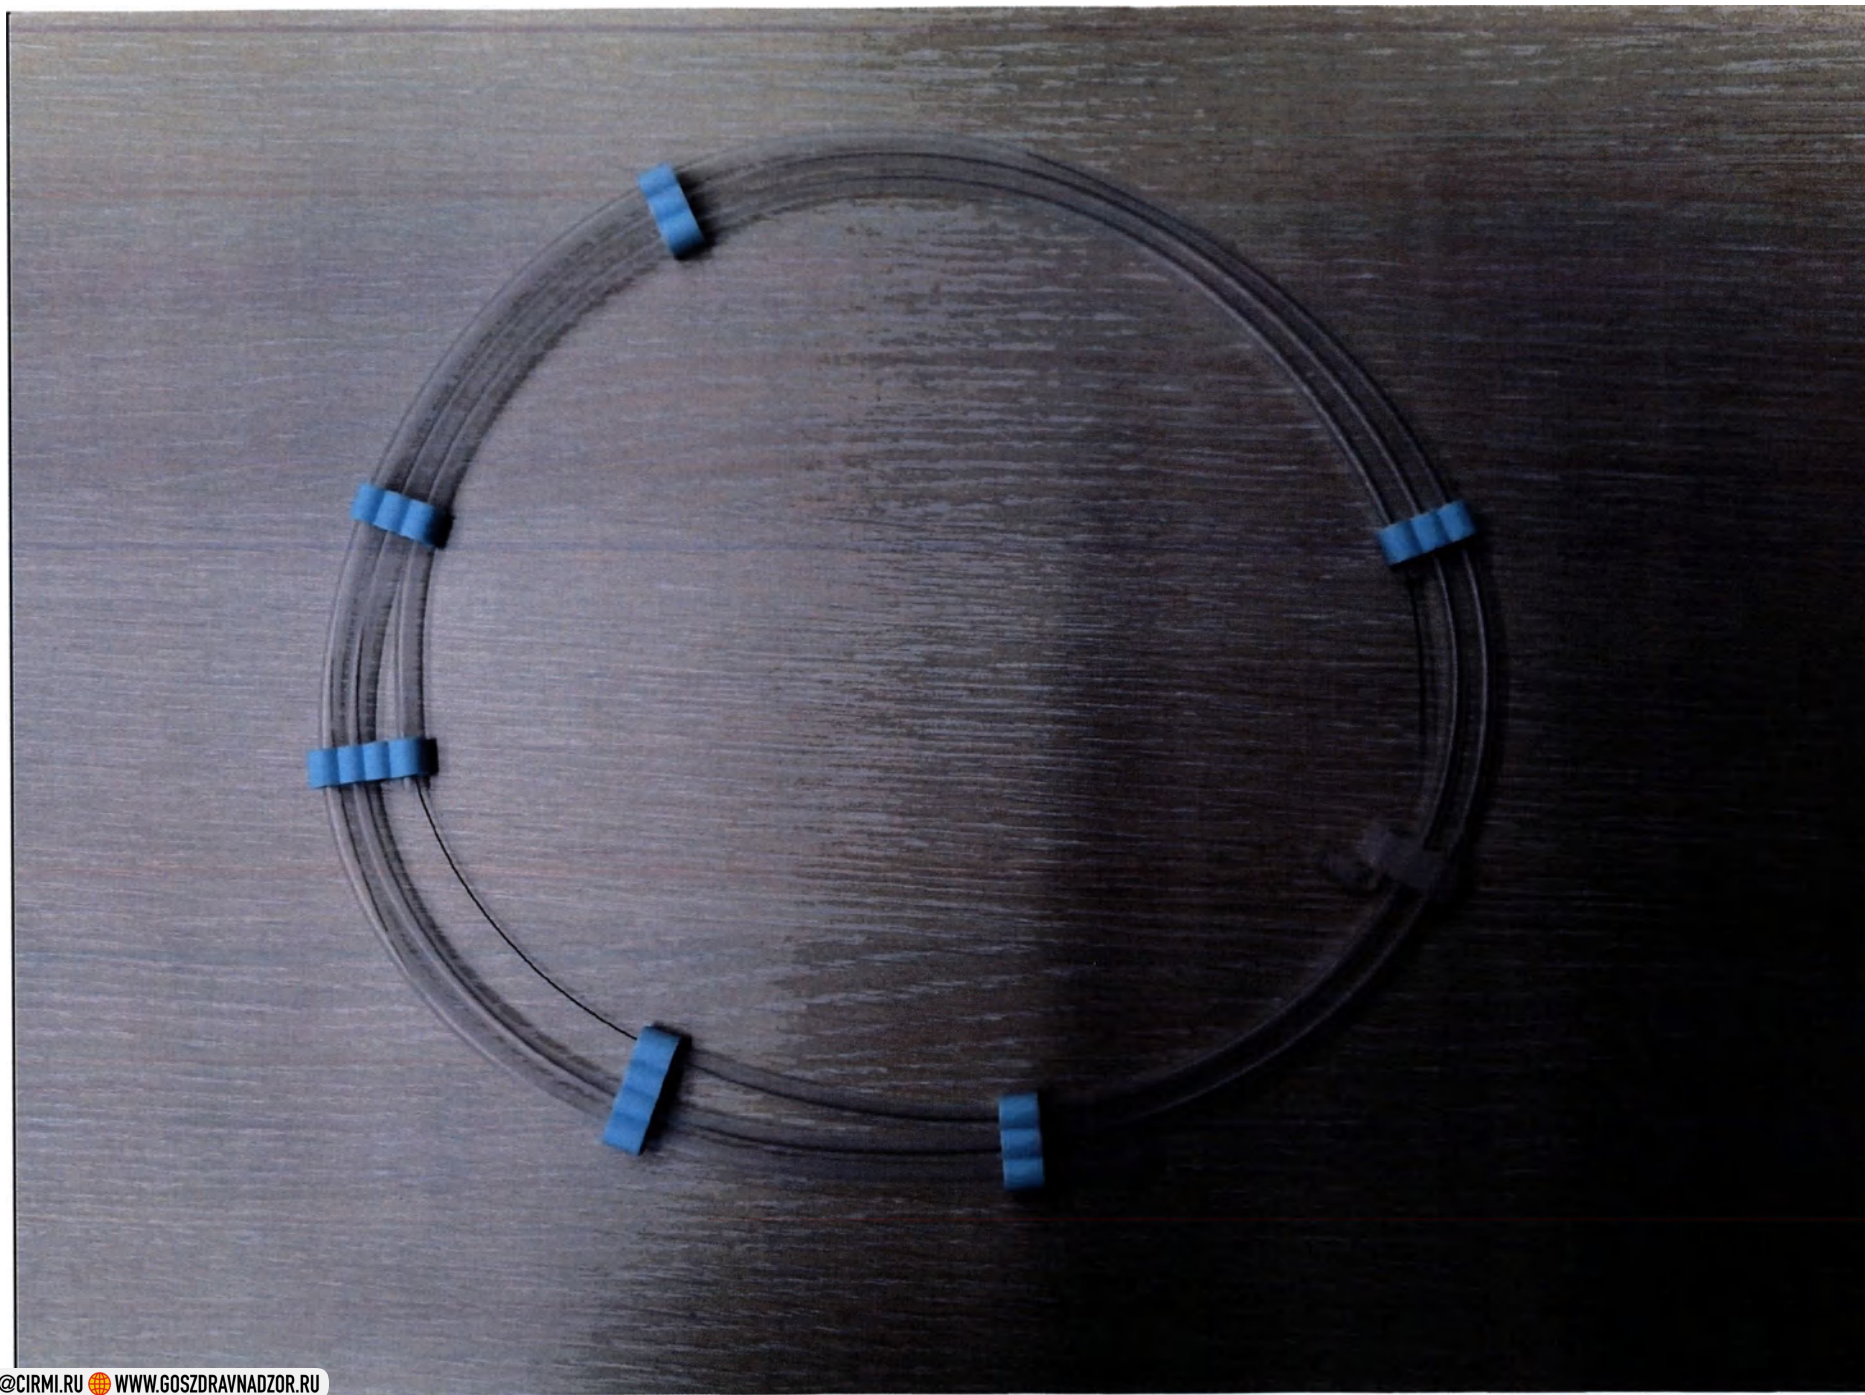

Устройства для рентгеноваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводники


Область применения: для использования в ангиографических
процедурах для введения и позиционирования катетеров и
интервенционных устройств
Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014. Произведено Lake
Region Medical, США
Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777
Рег. удост.: РЭН 2016/32272 от 16.11.2015



Артикул 518224 16306



Проводники STABILIZER PLUS

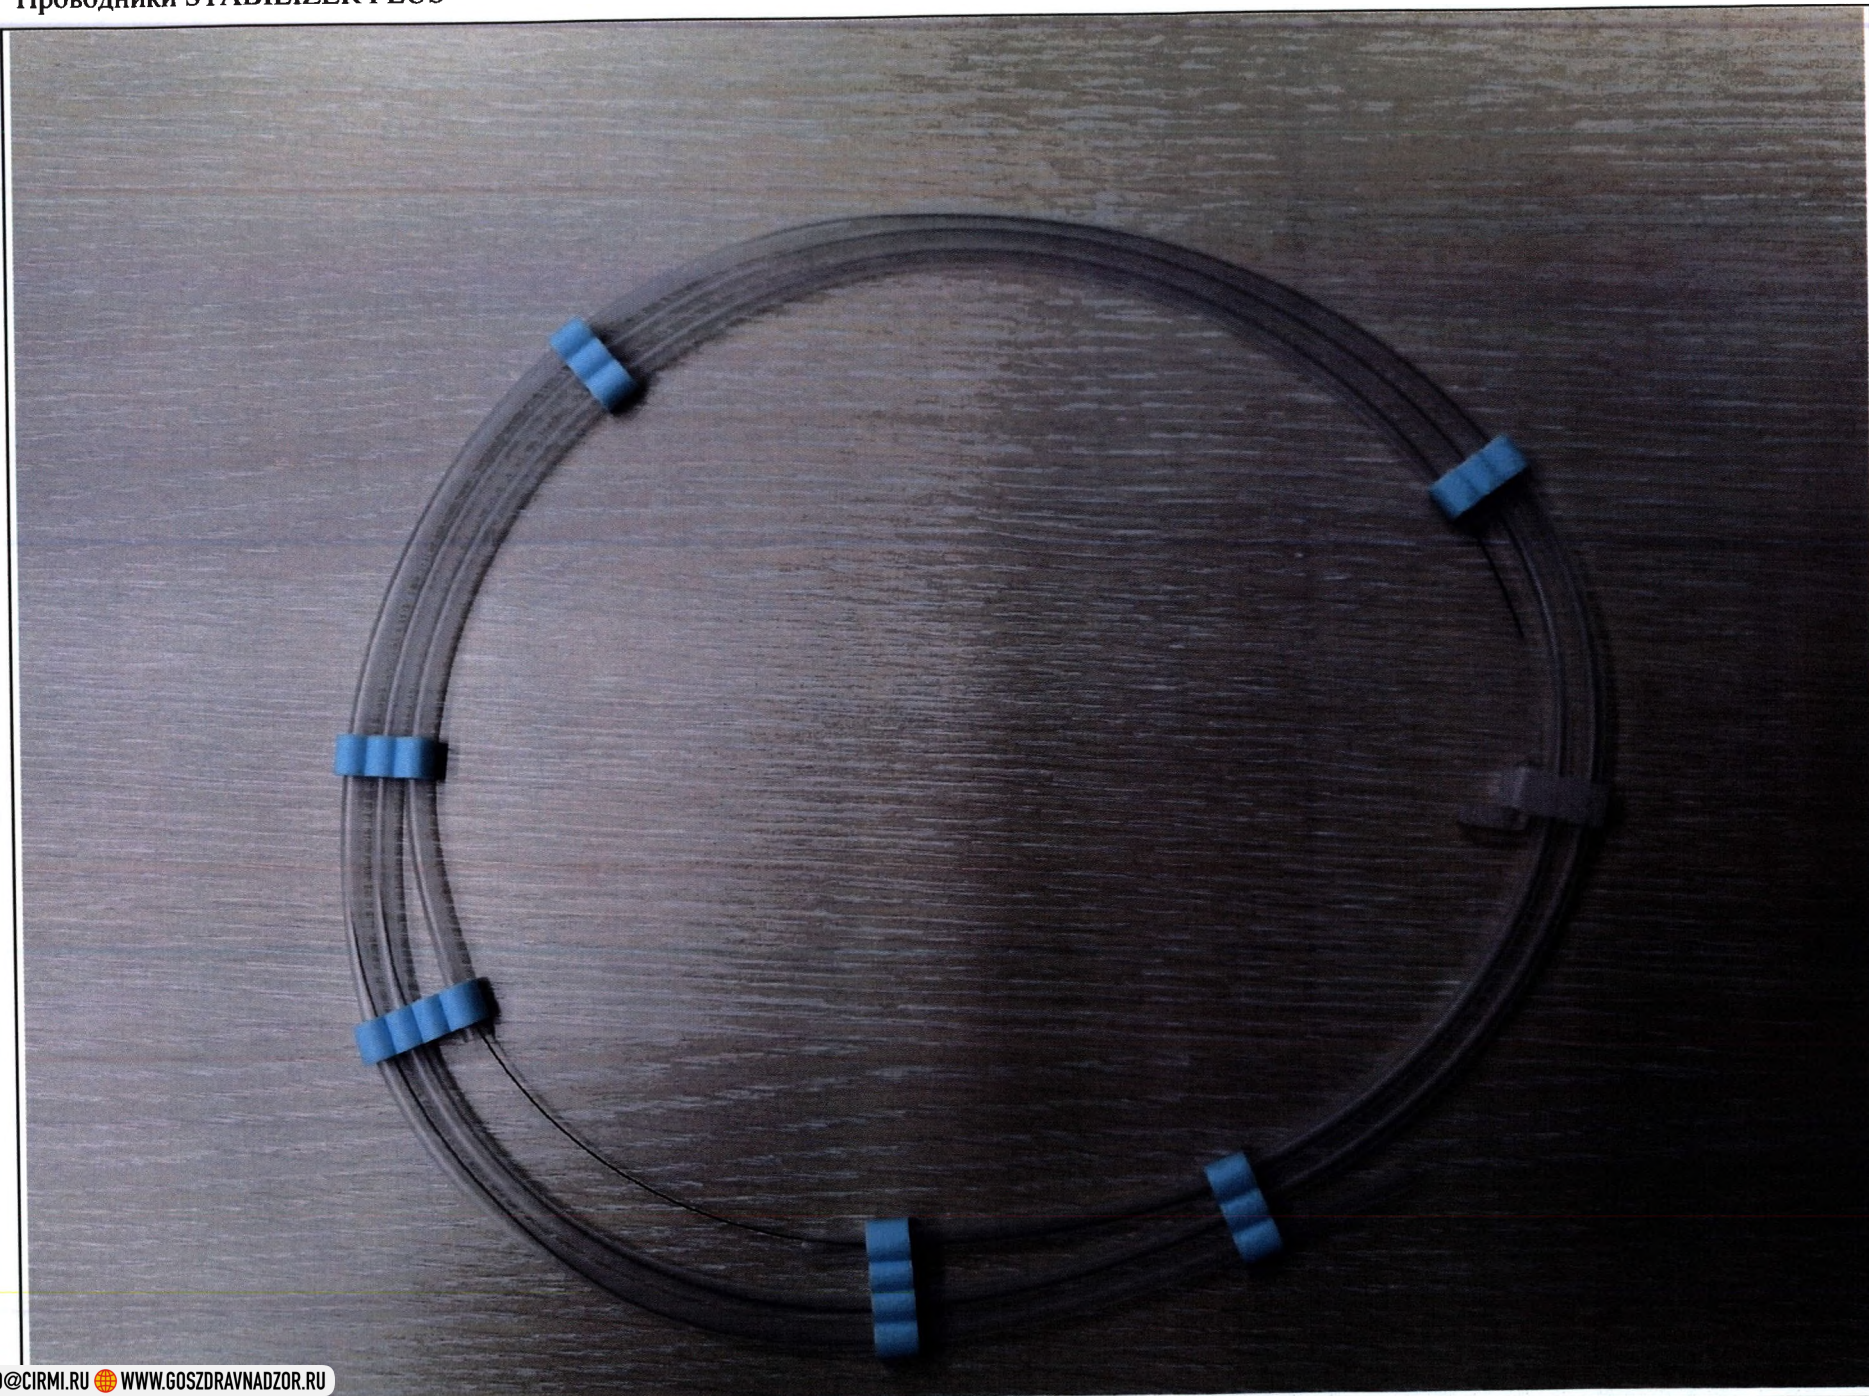

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник

Область применения: для использования в ангиографических
процедурах для введения и позиционирования катетеров и
интервенционных устройств

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014. Произведено Lake
Region Medical, США

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777
Пер. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015

Артикул 507114J 16306



[illegible][illegible]



Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник

Область применения: для использования в ангиографических
процедурах для введения и позиционирования катетеров и
интервенционных устройств

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014. Произведено Lake
Region Medical, США

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 527180E 16306

STABILIZER®

REF
Cat. No.

507-300S

SUPPORT

Steerable Guidewire / Guide orientable
Steuerbare Führungsdraht / Guida direzioneale
Guis dirigible / Stuurbare voorstraad
Stijlbaar guideweer / Cháiticea (seamable) jhóidín
Fis gais dírceonaise / Stijlbaar ledare
Gaidhíthreanna Mairbhúndrúpaí Zópa
スティールブル・ガイドワイヤ

300 cm

3 cm

.014"
(0.36 mm)

Tip Flexibility
SuperSoft

Flex. extrémě; extrasouple
Flex. der Spitze: extra-weich
Flexibilidad punta: ultramortida
Flexibilidad de la punta: extra blanda
Tűspiczakmősség: superpuh
Spichflexibilität: superflach
Kérgen puhasága: extrém puha
Flexibilidade da extremidade: supermofo
Spíochleaghaí: eantúil
Elasticidad Anpós: íolú Málaid
先端の柔軟性: スーパーソフト

Cordis
a Johnson & Johnson company

Endovascular

Manufactured for
Cordis Corporation
14201 North West 60th Avenue
Miami Lakes, Florida 33014, USA

EC REP

LOT No. **35227287**

Use By **2017-09**

Cordis Cashel
Cashel Road
Cashel, CO Tipperary
Ireland

CE 0086 11344855 1


STABILIZER®
REF
Cat. No.
507-300S

SUPPORT

5 Steerable Guidewires
5 guides extensibles / 5 Steerbare Führungsdrahte
5 guide distorsion / 5 guide dirigibles
5 maubere veldsteken / 5 Bytaren guidewires
5 kpi oipetaves yidrida / 5 For gus distorsioneres
5 guiden ledere / 5 Steerbarer Kirschebrenner 2000mm
スチーラブル・ガイドワイヤ5本

LOT 35227287
Lot No.

Use By 2017-09

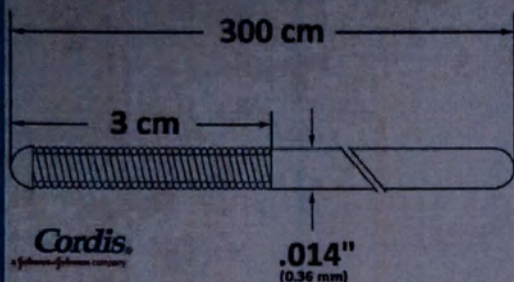

Cordis
a Johnson & Johnson company

Endovascular

**Tip Flexibility
SuperSoft**

Plus extrême: extracouple
Plus de flexibilité: extra-soft
Flexibilité de la pointe: extra-blanche
Tobuigsenheit: superzich
Spitstekelbaarheid: superzich
Käfen: postelvat: eritän: pefmek
Flexibilidade da extremidade: superzich
Spitstekelbaarheid: superzich
Eccupole: super: Tolo: Molead
先端の柔軟性: スーパーソフト

Manufactured for
Cordis Corporation
14201 North West 60th Avenue
Miami Lakes, Florida 33014, USA

EC REP

Cordis Cashel
Cahir Road,
Cashel, CO Tipperary
Ireland

CE 0086 11344804.1



STERILE
滅菌済

STERILE
滅菌済

Sterilized with ethylene oxide gas.
エチレンオキシドガス滅菌済

For one use only.
1回のみ使用



Attention: see instructions for use. / Attention: voir le mode d'emploi. / Achtung: Gebrauchsanleitung beachten. / Atención: consulte las instrucciones de uso. / Let op: raadpleeg de gebruiksaanwijzing. / Bemærk: Se brugsanvisningen. / Huomio: Katso käyttöohjeita. / Atenção: Consulte as instruções de utilização. / OBS: Se brugsanvisningen. / Προσοχή, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης.
注: 使用説明書をご確認ください。

Nonpyrogenic. Radiopaque. Do not autoclave. Do not use open or damaged packaging. Store in a cool, dark, dry place. Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Irrygène. Radio opaque. Ne pas stériliser. Ne pas utiliser si le paquet est ouvert ou endommagé. A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

REF Catalog No.
カタログ番号

LOT Lot No.
ロット番号

Use By
使用期限

Pyrogenfrei. Röntgenachtbar. Nicht autoklavierbar. Keine öffnen oder beschädigten Packungen benutzen. Trocken, dunkel und kühl aufbewahren.

Apyrogeno. Radiopaco. Non sterilizzare in autoclave. Non usare confezioni aperte o danneggiate. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce.

Apirógeno. Radiopaco. No reesterilizar en autoclave de vapor de agua. No utilizar si el envase no está íntegro. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y seco. Usar una vez y destruir. El uso compartido constituye riesgo de infección.

Pyrogeenvrij. Radiopac. Niet in een autoclaaf behandelen. Open of beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Droog, donker en koel bewaren.

Ikke feberfrembringende. Røntgenfast. Udsæt ikke for autoclave. Brug ikke åbnede eller beskadigede pakker. Opbevares koldt, mørkt og tørt.

Pyrogeniton. Röntgenpositiivinen. Ei saa autoklavoids. Ävonelele tai vaurioituneita pakkauksia ei saa käyttää. Säilytettävä, viileässä, pimeässä ja kuivassa.

Apyrogenico. Radio-opaco. Não esterilize em autoclave. Não use embalagens abertas ou danificadas. Conservar num local fresco, seco e escuro.

Pyrogenfri. Röntgenått. För ej autoklaveras. Öppnade eller skadade förpackningar får ej användas. Förvaras på ett svalt, mörkt och torrt ställe.

Μη-πυρογόνο. Αδυναμικές στις ακτίνες. Μην το αποστειρώνετε σε κλίβανο αποστείρωσης. Μην χρησιμοποιείτε σε συσκευασίες οι οποίες έχουν ανοιχτεί ή έχουν πόλα ζημία. Φυλάξτε το σε ήρερο, σκοτεινό και ξηρό χώρο.

非炎熱性。X線透過性。オートクレーブにかけないで下さい。包装が開封されたり破損している場合は、使用しないで下さい。涼気を保ち、暗所に保管して下さい。

Manufactured for / Fabriqué pour / Hergestellt für
Prodotto per / Fabricado para / Vervaardigd voor
Fremstillet for / Valmistuttaja / Fabricado para / Tillverkad för
Παρασκευαστικός για την / のために製造...

Cordis Corporation
14201 North West 60th Avenue
Miami Lakes, Florida 33014, USA

EC REP

Cordis Cashel
Cahir Road, Cashel
Co Tipperary, Ireland

1551445.2

**Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник**

Область применения: для использования в ангиографических
процедурах для введения и позиционирования катетеров и
интервенционных устройств

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014. Произведено Lake
Region Medical, США

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"


121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 507300S 16306

Проводники STABILIZER BALANCED PERFORMANCE

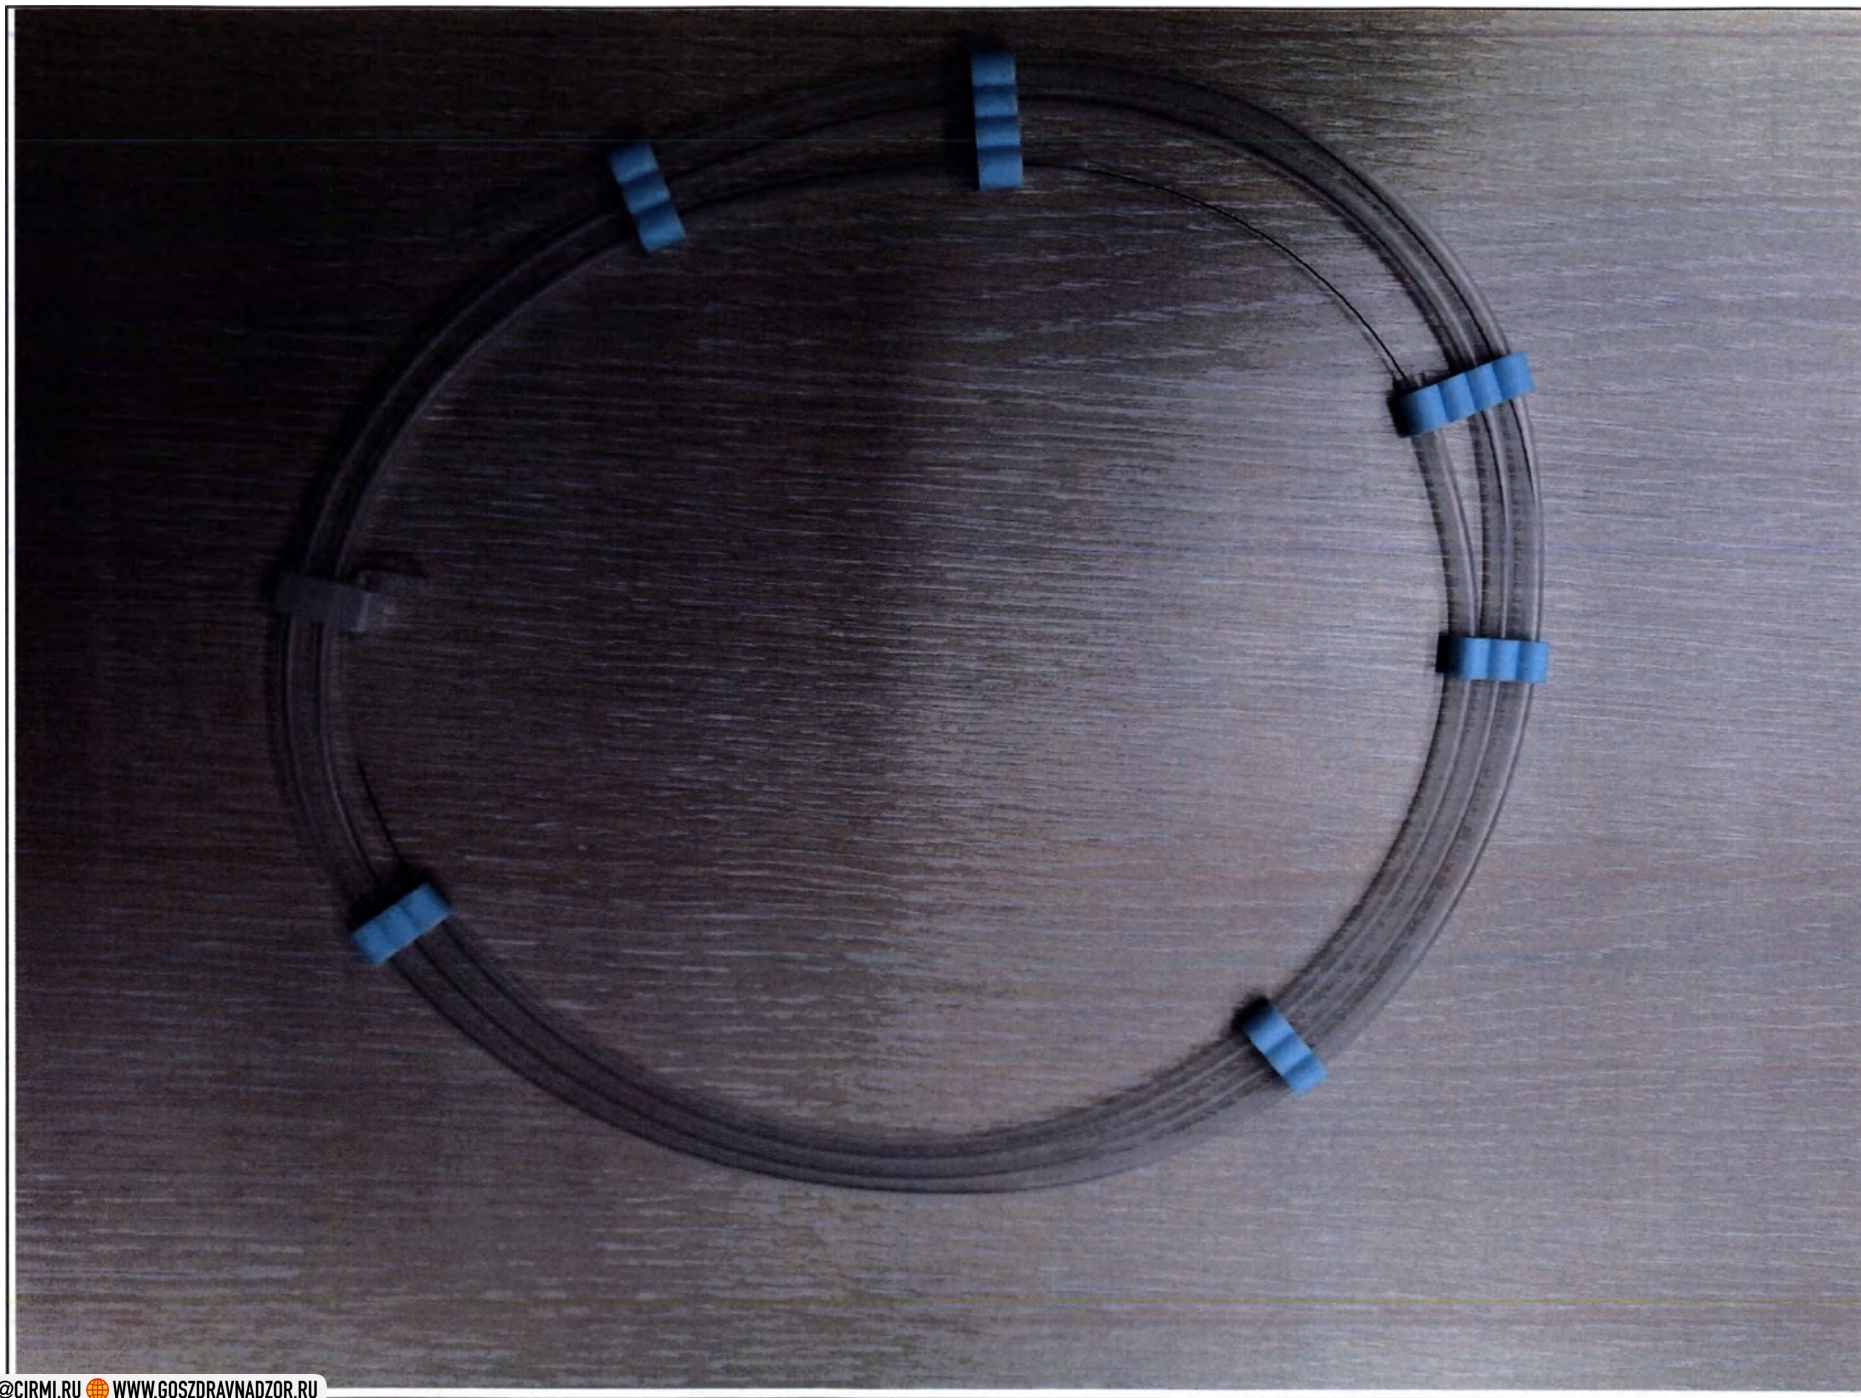

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник

Область применения: для использования в ангиографических
процедурах для введения и позиционирования катетеров и
интервенционных устройств

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордио Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014. Произведено Lake
Region Medical, США

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777


Per. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 507300S 16306



!
зец.
и!

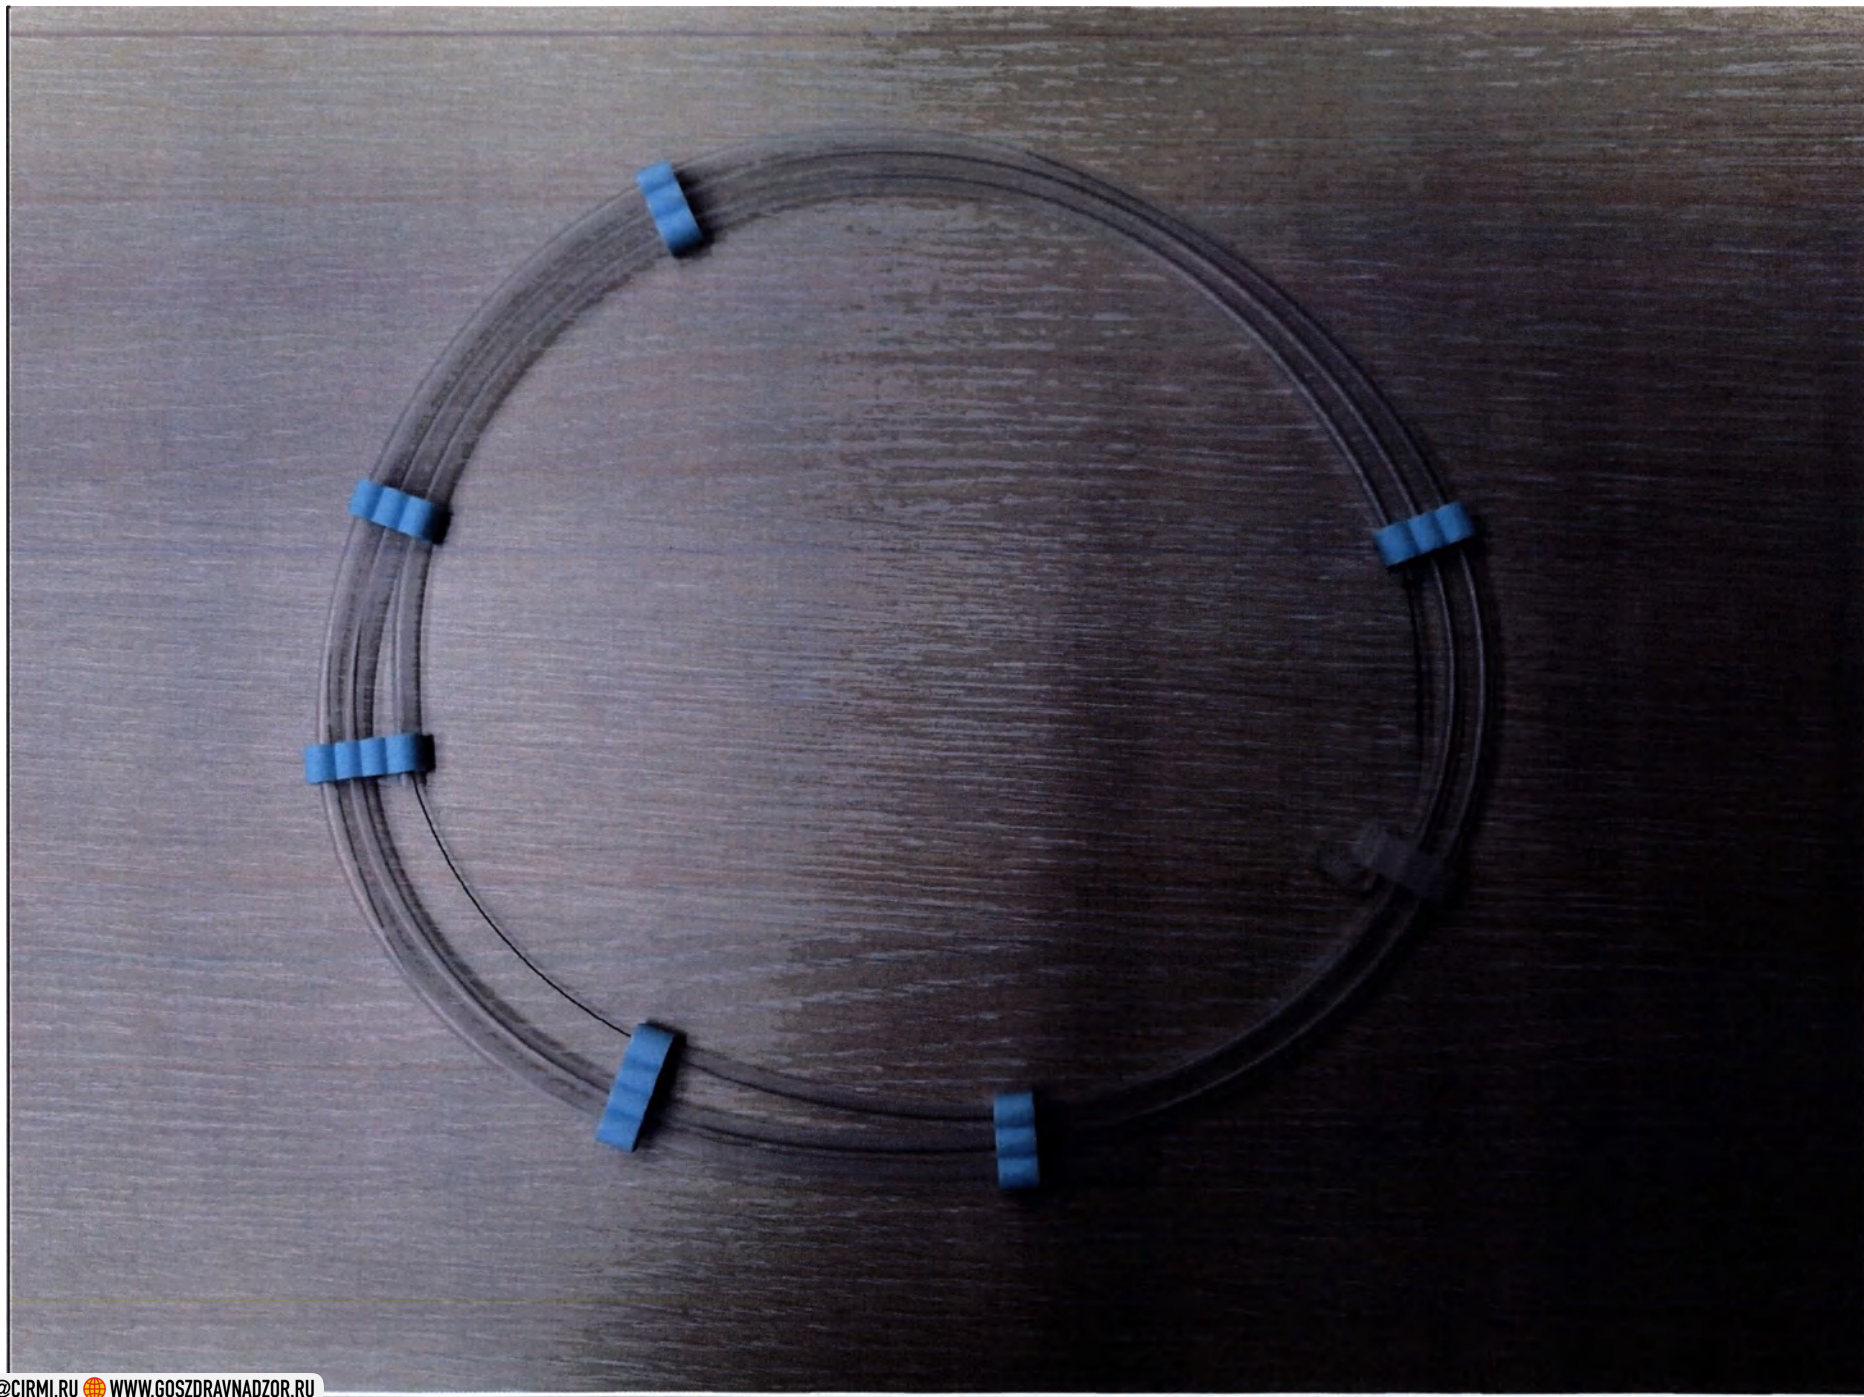

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник

Область применения: для использования в ангиографических
процедурах для введения и позиционирования катетеров и
интервенционных устройств

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордио Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014. Произведено Lake
Region Medical, США

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Per. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 507300S 16306



!
зец.
и!

STERILE / STERIL / ESTERIL / STERIL / STERILI / ESTERILIZADO / ESTERIFOMENO
 無菌清

STERILE Sterilized with ethylene oxide gas. / Sterilisé à l'oxyde d'éthylène. / Sterilisiert mit Ethylenoxid-Gas. / Sterilizzato con ossido di etilene. / Esterilizado con óxido de etileno. / Esterilizado med etylenoxidgas. / Sterilisiert med etylenoxidgas. / Sterilizzato con gas de óxido de etileno. / Sterilizzato med etylenoxidgas. / Autosterilizável por óxido de etileno. / エチレンオキサイドガス滅菌済

For one use only. / A usage unique. / Nur zum Einmalgebrauch. / Da usare una volta sola. / Para un solo uso. / Nur einmalig gebrauch. / Kun til engangsbrug. / Kattilayhdyttöns. / Para uso único. / Endast för engångsbruk. / Kātsi, jāizmanto vienreiz. / 1回のみの使用

REF Catalog No. / N° de catálogo / Katalog-Nr. / Catalogo n. / N° de catálogo / Catalogue-Nr. / Katalognr. / Katalog nr. / Αριθμός Καταλόγου / Каталог №

Lot No. / Lot N° / Ch.-B. / Lote n. / N° de lote / Partijnr. / Varsel / Erke / Nr do lotu / Baza nr. / Αριθμός Παρτίδας / Лот №

Use By / Utiliser jusque / Verwendbar bis Ende / Usare entro / Fecha de caducidad / Uterste gebruijksdatum / Användes inden / Käyttävä ennen / Prazo de validade / Förbrukas senast / Avslutas Måst / 使用期限

Attention, see instructions for use. / Attention, voir le mode d'emploi. / Achtung: Gebrauchsanleitung beachten. / Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso. / Attention, consultarse las instrucciones de uso. / Let op: raadpleeg de gebruiksaanwijzing. / Benutze die gebruiksaanwijzing. / Húsnagy: Kérlek használd helyesen. / Atenção: Consulte as instruções de utilização. / OBS: Se bruksanvisningen. / Οδηγίες, αναγνώστε πριν. / Обращение: Смотрите инструкцию перед использованием.

Nonpyrogenic. Radioopaque. Do not autoclave. Do not use open or damaged packages. Store in a cool, dark, dry place. Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Apyrogeno. Radio-opaco. Ne pas stériliser. Ne pas utiliser si le paquet est ouvert ou endommagé. A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Pyrogenfrei. Röntgensichtbar. Nicht autoklavieren. Keine offenen oder beschädigten Packungen benutzen. Trocken, dunkel und kühl aufbewahren.

Apyrogeno. Radioopaco. Non sterilizzare in autoclave. Non usare confezioni aperte o danneggiate. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalle luci.

Apirógeno. Radioopaco. No reesterilizar en autoclave de vapor de agua. No utilizar si el envase no está íntegro. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y seco. Usar una vez y destruir. El uso compartido conlleva riesgo de infección.

Pyrogenvrij. Radiopaak. Niet in een autoclaaf behandelen. Open of beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Voor de uiterste gebruiksdatum gebruiken. Droog, donker en koel bewaren.

Ikke feberfrembringende. Røntgenfast. Udset ikke for autoclave. Brug ikke åbnede eller beskadigede pakker. Opbevares koldt, mørkt og tørt.

Pyrogeenitön. Ei saa autoklavoida. Avonalaista tai vaurioituneita pakkauskala ei saa käyttää. Säilytettävä viileässä, pimeässä ja kuivassa.

Apirogénico. Radio-opaco. Não esterilize em autoclave. Não use embalagens abertas ou danificadas. Conserve num local fresco, escuro e seco.

Pyrogenfri. Röntgenlar. Får ej autoklaveras. Öppnade eller skadade förpackningar får ej användas. Förvaras på ett kallt, mörkt och torrt ställe.


Μη πυρογενές. Αδιαφανές στις ακτίνες. Μην το αποστειρώνετε σε κλειμένο αποστειρωτή. Μη χρησιμοποιείτε ανοικτές ή οι οποίες έχουν ανοίξει ή έχουν υποστεί ζημιά φιάλες το σε άμεσο σκοτεινό και ξηρό χώρο

注意事項。×線不透過性。オートクレーブにかけないで下さい。包装が開封されたり破損している場合は、使用しないで下さい。涼爽を避け、冷暗所に保管して下さい。

Manufactured for / Fabriqué pour / Hergeetelt für / Prodotto per / Fabricado para / Vervaardigd voor / Fremstillet for / Valmistuttaja / Fabricado para / Fabricado por / Παράσκευαστηκε για την / 製造元
 Cordis Corporation, P.O. Box 026700,
 Miami, FL 33102-5700, USA

**Cordis Europe N.V., Postbus 38,
 6300 AA Roden, The Netherlands.
 Rappresentante in Italia:
 Cordis Italia S.p.A.,
 I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
 Cordis Medizinische Apparate GmbH, D-42781 Hain
 Representante en España: Johnson & Johnson S.A.
 Paseo de las doce Estrellas 5 7, 28047 Madrid**

153-1978-1

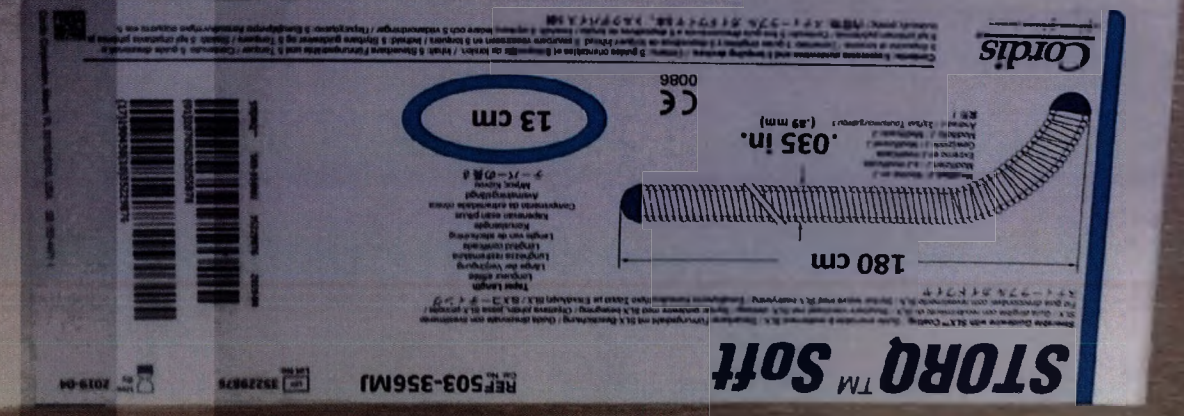



Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводники

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордио Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 503356MJ, 16266


SV-8

REF 503-658

LOT 35226656

Mfr By 2017-07

5 Stereable Guidewires / 5 guides orientables / 5 Stereable Führungsdrahte / 5 guide directionali / 5 guias dirigibles / 5 sturbara spårtrådar / 5 Rytbare guidewires / 5 kpl. druzinych plynch / 5 Fier gus directoare / 5 sturbara ledare / 5 Eukipitvina Kottuvelvina Tiquara / スティラブル・ガイドワイヤ5本

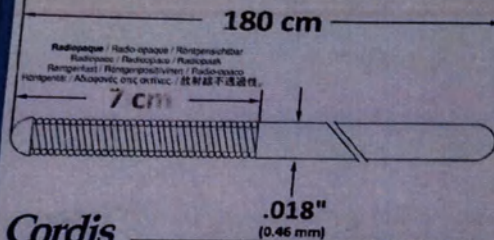

Cordis
ENDOVASCULAR

Contents: 5 stereable guidewires and 5 torquing device. / Contenu: 5 guides orientables et 5 dispositifs de torsion. / Inhalt: 5 Stereable Führungsdrahte und 5 Torsoren. / Contenido: 5 guide directionali e 5 kpl. druzinych plynch. / Conteúdo: 5 Fier gus directoare e 5 sturbara voerdoren en 5 Torsoren. / Contenido: 5 Rytbare guidewires og 5 Torquere. / Contenido: 5 kpl. druzinych plynch e 5 kpl. druzinych plynch. / Contenido: 5 Eukipitvina Kottuvelvina Tiquara e 5 Eukipitvina Kottuvelvina Tiquara. / スティラブル・ガイドワイヤ5本、トルクデバイス5個

Taper Length
Longueur effile
Länge der Verjüngung
Lunghezza rastomatura
Longitud conicalada
Länge van de afsmalning
Konsalengde
Kantoor van plaat
Comprimento da extremidade cônica
Avenningstengde
Målelængde
テーパーの長さ

8 cm

CE 0086

STERILE 滅菌済

STERILE EO

Sterilized with ethylene oxide gas.
エチレンオキシドガス滅菌済

For one use only.
1回のみ使用



Attention, see Instructions for Use. / Attention, voir le mode d'emploi. / Achtung: Gebrauchsanleitung beachten. / Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso. / Atención, consulte las instrucciones de uso. / Let op: raadpleeg de gebruiksaanwijzing. / Bemærk: Se brugsanvisningen. / Huom: Katso käyttöohjeita. / Atanção: Consulte as Instruções de Utilização. / OBS: Se brugsanvisningen. / Προσοχή, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης. 注: 使用説明書をご参照ください。

Nonpyrogenic. Radiopaque. Do not autoclave. Do not use open or damaged packages. Store in a cool, dark, dry place. Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Apyrogène. Radio-opaque. Ne pas stériliser. Ne pas utiliser si le paquet est ouvert ou endommagé. A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

REF Catalog No. カタログ番号

LOT ロット番号

Use By 使用期限

Pyrogenfrei. Röntgensichtbar. Nicht autoklavieren. Keine offenen oder beschädigten Packungen benutzen. Trocken, dunkel und kühl aufbewahren.

Apirogeno. Radiopaco. Non sterilizzare in autoclave. Non usare confezioni aperte o danneggiate. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce.

Apirógeno. Radiopaco. No reesterilizar en autoclave de vapor de agua. No utilizar si el envase no está íntegro. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y seco. Usar una vez y destruir. El uso compartido constituye riesgo de infección.

Pyrogeenvrij. Radiopaak. Niet in een autoclaaf behandelen. Open of beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Droog, donker en koel bewaren.

Ikke feberfrembringende. Røntgenfast. Udsæt ikke for autoklave. Brug ikke åbnede eller beskadigede pakker. Opbevares køligt, mørkt og tørt.

Pyrogeenitön. Röntgenpositiivinen. Ei saa autoklavoida. Ävonelela tai vaurioituneita pakkauskala ei saa käyttää. Säilytettävä, viileässä, pimeässä ja kuivassa.

Apirogénico. Radio-opaco. Não esterilize em autoclave. Não use embalagens abertas ou danificadas. Conserve num local fresco, escuro e seco.

Pyrogenfri. Röntgentit. Får ej autoklaveras. Öppnade eller skadade förpackningar får ej användas. Förvaras på ett svalt, mörkt och torrt ställe.

Μη-πυρετογόνο. Αδρανές στις ακτίνες. Μην το αποστειρώνετε σε κλίβανο αποστείρωσης. Μην χρησιμοποιείτε συσκευασίες οι οποίες έχουν ανοιχτεί ή έχουν πόδες ζημιάς. Φυλάξτε το σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό χώρο.

非発熱性。X線不透過性。オートクレーブにかけないで下さい。包装が割れたり破損している場合は、使用しないで下さい。涼気を避け、暗所に保管して下さい。

Manufactured for / Fabriqué pour / Hergestellt für
Prodotto per / Fabricado para / Vervaardigd voor
Fremstillet for / Valmistuttaja / Fabricado para / Tillverkad för
Παρασκευάστηκε για την / のために製造。

Cordis Corporation
14201 North West 60th Avenue
Miami Lakes, Florida 33014, USA

EC REP
Cordis Catheter
Cahir Road, Cahir
Co Tipperary, Ireland



Проводник

Область применения: Хирургия

Условия хранения Хранить при температуре не выше 25°

Избегать контакта с влагой и направленным жаром Не
использовать после истечения срока хранения

Срок годности. См. на упаковке

Производитель См. на упаковке

Импортер ООО "Джонсон&Джонсон"

121614, Москва ул. Крылатская д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост. 2015/3272 от 16.11.2015

Орган сертификации



Артикул 503658 16120

WIZDOM™
REF
Cat No. **337-114J**

ST

5 Steerable Guidewires
5 guides orientables / 5 Steuerbare Führungsdraht
5 guide directional / 5 guida dirigibile
5 stuurbare voorleiden / 5 stuurbare guidewires
5 tyyl suuntaava johdinta / 5 Fios para direcionavel
5 stýbiera lodi / 5 Ευκαμπής Οδηγός / 5 Ευκαμπής Οδηγός
スティールラブル・ガイドワイヤ5本

180 cm

3 cm

0.014"
(0.36 mm)

Cordis
a Johnson & Johnson company

Tip Flexibility Floppy

Flex. extremité souple
Flex. der Spitze floppy
Flexibilidad punta punta muelle
Flexibilidad de la punta: flexible
Työvägnastad släp
Bakofskärlslätt släp
Käijän joustavuus: erittäin joustava
Fleksibilität der extremidade: flexível
Spekterfleksibiliteit: slak
Ευκαμπή Άκρη: Ελαστική
先端の柔軟性：フロッピー

LOT 35228630
Lot No.

2017-12

WIZDOM™ ST 337-114J LOT 35228630
[01280760037056479]
[171712211035328630]

CE
0086

Manufactured for
Cordis Corporation, Miami, FL, USA 33156-5011

STERILE
滅菌済

STERILE
滅菌済

Sterilized with ethylene oxide gas.
エチレンオキサイドガス滅菌済

For one use only.
1回のみ使用

Attention, see Instructions for Use. / Attention, voir le mode d'emploi. / Achtung: Gebrauchsanleitung beachten. / Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso. / Atención, consulte las instrucciones de uso. / Let op: raadpleeg de gebruiksaanwijzing. / Bemærk: Se brugsanvisningen. / Huomio: Katso käyttöohjeita. / Atención: Consulte as Instruções de Utilização. / OBS: Se brugsanvisningen. / Προσοχή, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης. 注：使用説明書をご参照ください。

Nonpyrogenic. Radiopaque. Do not autoclave. Do not use open or damaged packages. Store in a cool, dark, dry place. Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Apyrogenic. Radio-opaque. Ne pas stériliser. Ne pas utiliser si le paquet est ouvert ou endommagé. A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

REF Catalog No.
カタログ番号

LOT Lot No.
ロット番号

Use By
使用期限

Pyrogenfrei. Röntgensichtbar. Nicht autoklavieren. Keine offenen oder beschädigten Packungen benutzen. Trocken, dunkel und kühl aufbewahren.

Apirogeno. Radiopaco. Non sterilizzare in autoclave. Non usare confezioni aperte o danneggiate. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce.

Apirógeno. Radiopaco. No reesterilizar en autoclave de vapor de agua. No utilizar si el envase no está íntegro. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y seco. Usar una vez y destruir. El uso compartido constituye riesgo de infección.

Pyrogeenvrij. Radiopaak. Niet in een autoclaaf behandelen. Open of beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Droog, donker en koel bewaren.

Ikke feberfrembringende. Røntgenfast. Udsæt ikke for autoclave. Brug ikke åbnede eller beskadigede pakker. Opbevares køligt, mørkt og tørt.

Pyrogeenitön. Röntgenpositiivinen. Ei saa autoklavoida. Avonsale tai vaurioituneita pakkauksia ei saa käyttää. Säilytettävä, viileässä, pimeässä ja kuivassa.

Apirogénico. Radio-opaco. Não esterilize em autoclave. Não use embalagens abertas ou danificadas. Conserve num local fresco, escuro e seco.

Pyrogenfri. Röntgenfö. För ej autoklaveras. Öppnade eller skadade förpackningar får ej användas. Förvaras på ett evall, mörkt och torrt ställe.

Μη-πυρογόνος. Αδραμερινός στις ακτίνες. Μην το αποστειρώνετε σε κλίβανο αυτοκλιπτικής. Μην χρησιμοποιείτε ανοικτές ή κατεστραμμένες συσκευασίες. Αποθηκεύστε σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό χώρο.

非炎熱性。X線不透過性。オートクレーブにかけないで下さい。包装が開封されたり破損している場合は、使用しないで下さい。湿気を避け、冷暗所に保管して下さい。

Manufactured for / Fabrikatör för / Tillverkare för
Prodotto per / Fabricado para / Fabrikado para / Tillverkad för
Παρασκευασμένο για την / Παρασκευασμένο για την

Cordis Corporation
14201 North West 58th Avenue
Miami Lakes, Florida 33014, USA

EC WSP
Cordis GmbH
Cable Road, Lathen
Go Tübingen, Germany

1051443.2



Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 537114J 16223

STERILE
無菌性

STERILE
無菌性

For use only
一人回りの使用

①

②

③

REF
カタログ番号

LOT
ロット番号

Use By
使用期限

Attention, see Instructions for Use / Attention, voir le mode d'emploi / Achtung, Gebrauchsanweisung lesen / Attenzione, leggere le istruzioni d'uso / Use only as directed / 指示通りに使用してください

STERILE
無菌性

STERILE
無菌性

For use only
一人回りの使用

①

②

③

STERILE
無菌性

STERILE
無菌性

For use only
一人回りの使用

①

②

③

REF
カタログ番号

LOT
ロット番号

Use By
使用期限

Attention, see Instructions for Use / Attention, voir le mode d'emploi / Achtung, Gebrauchsanweisung lesen / Attenzione, leggere le istruzioni d'uso / Use only as directed / 指示通りに使用してください

STERILE
無菌性

STERILE
無菌性

For use only
一人回りの使用

①

②

③

DURAGLIDE™
Coated
for Extra Lubricity

CINCH® QR

REF **502-144**

Cat. No. **35225209**

Lot No. **2018-03**

Extension Wire with DURAGLIDE™ Coating.

Compatible with all Extendible Cordis Steerable Guidewires.

Fil de rallonge à revêtement DURAGLIDE. Compatible avec tous les guides orientables étendables Cordis. / Drahtverlängerung mit DURAGLIDE-Beschichtung. Kompatibel mit allen verlängerbaren Cordis Stauerebaren Führungsdrähten. / Prolunga per guida con rivestimento DURAGLIDE. Compatibile con tutte le guide direzionali prolungabili Cordis. / Guía de extensión con recubrimiento de DURAGLIDE. Compatible con todas las guías dirigibles de Cordis que sean extensibles. / Verlengingsdraad met DURAGLIDE coating. Compatibel met alle verlengbare Cordis stuurbare voerdraden. / Forlænger med DURAGLIDE belægning. Kompatibel med alle forlængerbare Cordis styrbare Guidewires. / DURAGLIDE pinnoitattu johtimien jatke. Yhteensopiva kaikkien Cordis Steerable ohjainten kanssa. / Fio de extensão com revestimento DURAGLIDE. Compatível com todos os fios guias direcionáveis extensíveis Cordis. / Förlängningsled med Duraglideöverslag. Kompatibel med alla Cordis förlängbara styrbare ledare. / Σόκιο Επέκτασης με Επιστρώση DURAGLIDE. Συμβατό με όλα τα Ευκαθίστητα Κοιευθυντήρια Σόκιο της Cordis με δυνατότητα επέκτασης / エクステンションワイヤ (DURAGLIDEコーティング) 全てのコーディス製エクステンション可能PTCA用ガイドワイヤと併用可

Usable Length / Longueur utile
Nutzbare Länge / Lunghezza utile
Längstid / Brukbar lengde

145 cm

Anvendelig længde / Käytöpitävyys
Comprimento Utilizável / Användbar längd
Χρησιμοποιήσιμο Μήκος / 有効長

Engaging / Attacher / Verbinden / Connessione / Acoplamiento
guía-extensión / Verstellen / Samenstellen / Kienitus /
Conectar / Flaming / couloir / 接続方法

Disengaging / Détacher / Ablösen / Distacco / Desacoplamiento
Loosening / Afschieten / Breken / Desconectar / Sårkoppling /
Αποσύνδεση / はずし方



Attention, see instructions for Use.



(01)10705032009560



(17)180331(10)35225209

Cordis
Johnson & Johnson company

Manufactured for:
Cordis Corporation, Miami, FL 33107-5700, USA

110-1000-1

CE
0086

ary, Ireland

1551445.2

Проводники CINCH QR

Проводник

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°.

Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не использовать после истечения срока хранения.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Cordis Corporation, USA.

Импортер: ООО "Джонсон&Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3272

Орган сертификации: -



Арт. икул 502144 15205

STERILE STERILIZED
無菌包装済 エチレンオキサイドガス滅菌済み

REF Catalog No.
カタログ番号

LOT Lot No.
ロット番号

Sterilized with ethylene oxide gas.
エチレンオキサイドガスで滅菌済み

For use only
（注）のみでの使用

USE BY 使用期限

Attention, see Instructions for Use. / Attention, voir le mode d'emploi. / Achtung, Gebrauchsanleitung beachten! / Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso. / Atención, consúltese las instrucciones de uso. / Let op raadpleging der gebruiksaanwijzing. / Benutten: zie gebruiksinstructies. / Usando: consulte as instruções de utilização. / OBS: Se brukningsanvisningen i förpackningen är översatt till svenska, använd denna översättning istället.

Do not use open or damaged packages. Store in a cool, dark, dry place. Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

STERILE STERILIZED
無菌包装済 エチレンオキサイドガス滅菌済み

REF Catalog No.
カタログ番号

LOT Lot No.
ロット番号

Sterilized with ethylene oxide gas.
エチレンオキサイドガスで滅菌済み

For use only
（注）のみでの使用


USE BY 使用期限

Attention, see Instructions for Use. / Attention, voir le mode d'emploi. / Achtung, Gebrauchsanleitung beachten! / Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso. / Atención, consúltese las instrucciones de uso. / Let op raadpleging der gebruiksaanwijzing. / Benutten: zie gebruiksinstructies. / Usando: consulte as instruções de utilização. / OBS: Se brukningsanvisningen i förpackningen är översatt till svenska, använd denna översättning istället.

Do not use open or damaged packages. Store in a cool, dark, dry place. Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

EU Authorized Representative
Coedia Europa N.V., Coediastraat 8
NL-3120 JJ Lisse, The Netherlands

Проводники ANGIOGUARD RX

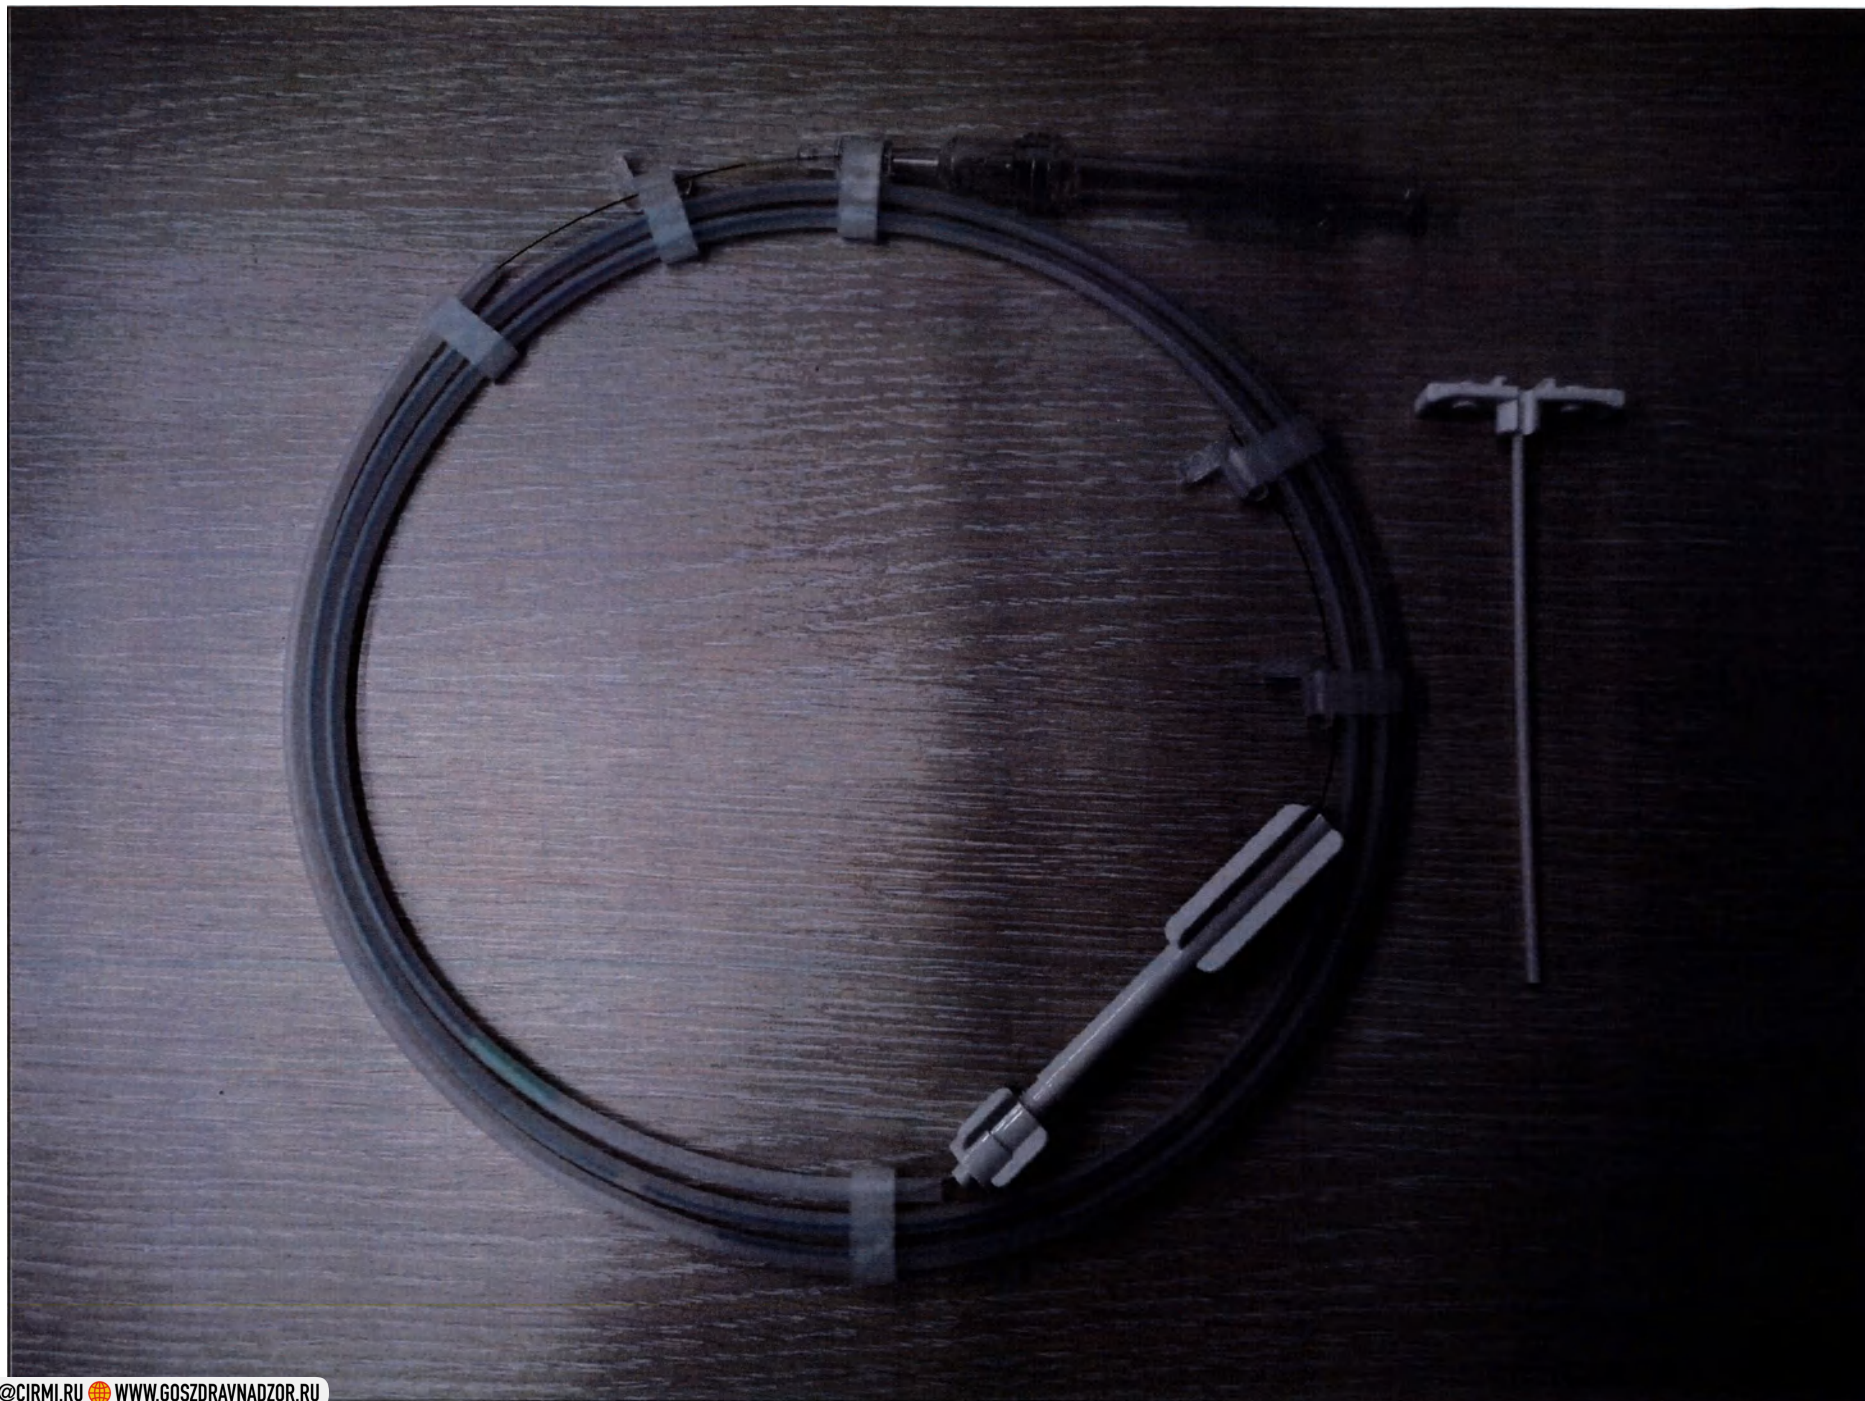

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: фильтр

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"


121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777


Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 601814RE 16266

ANGIOGUARD

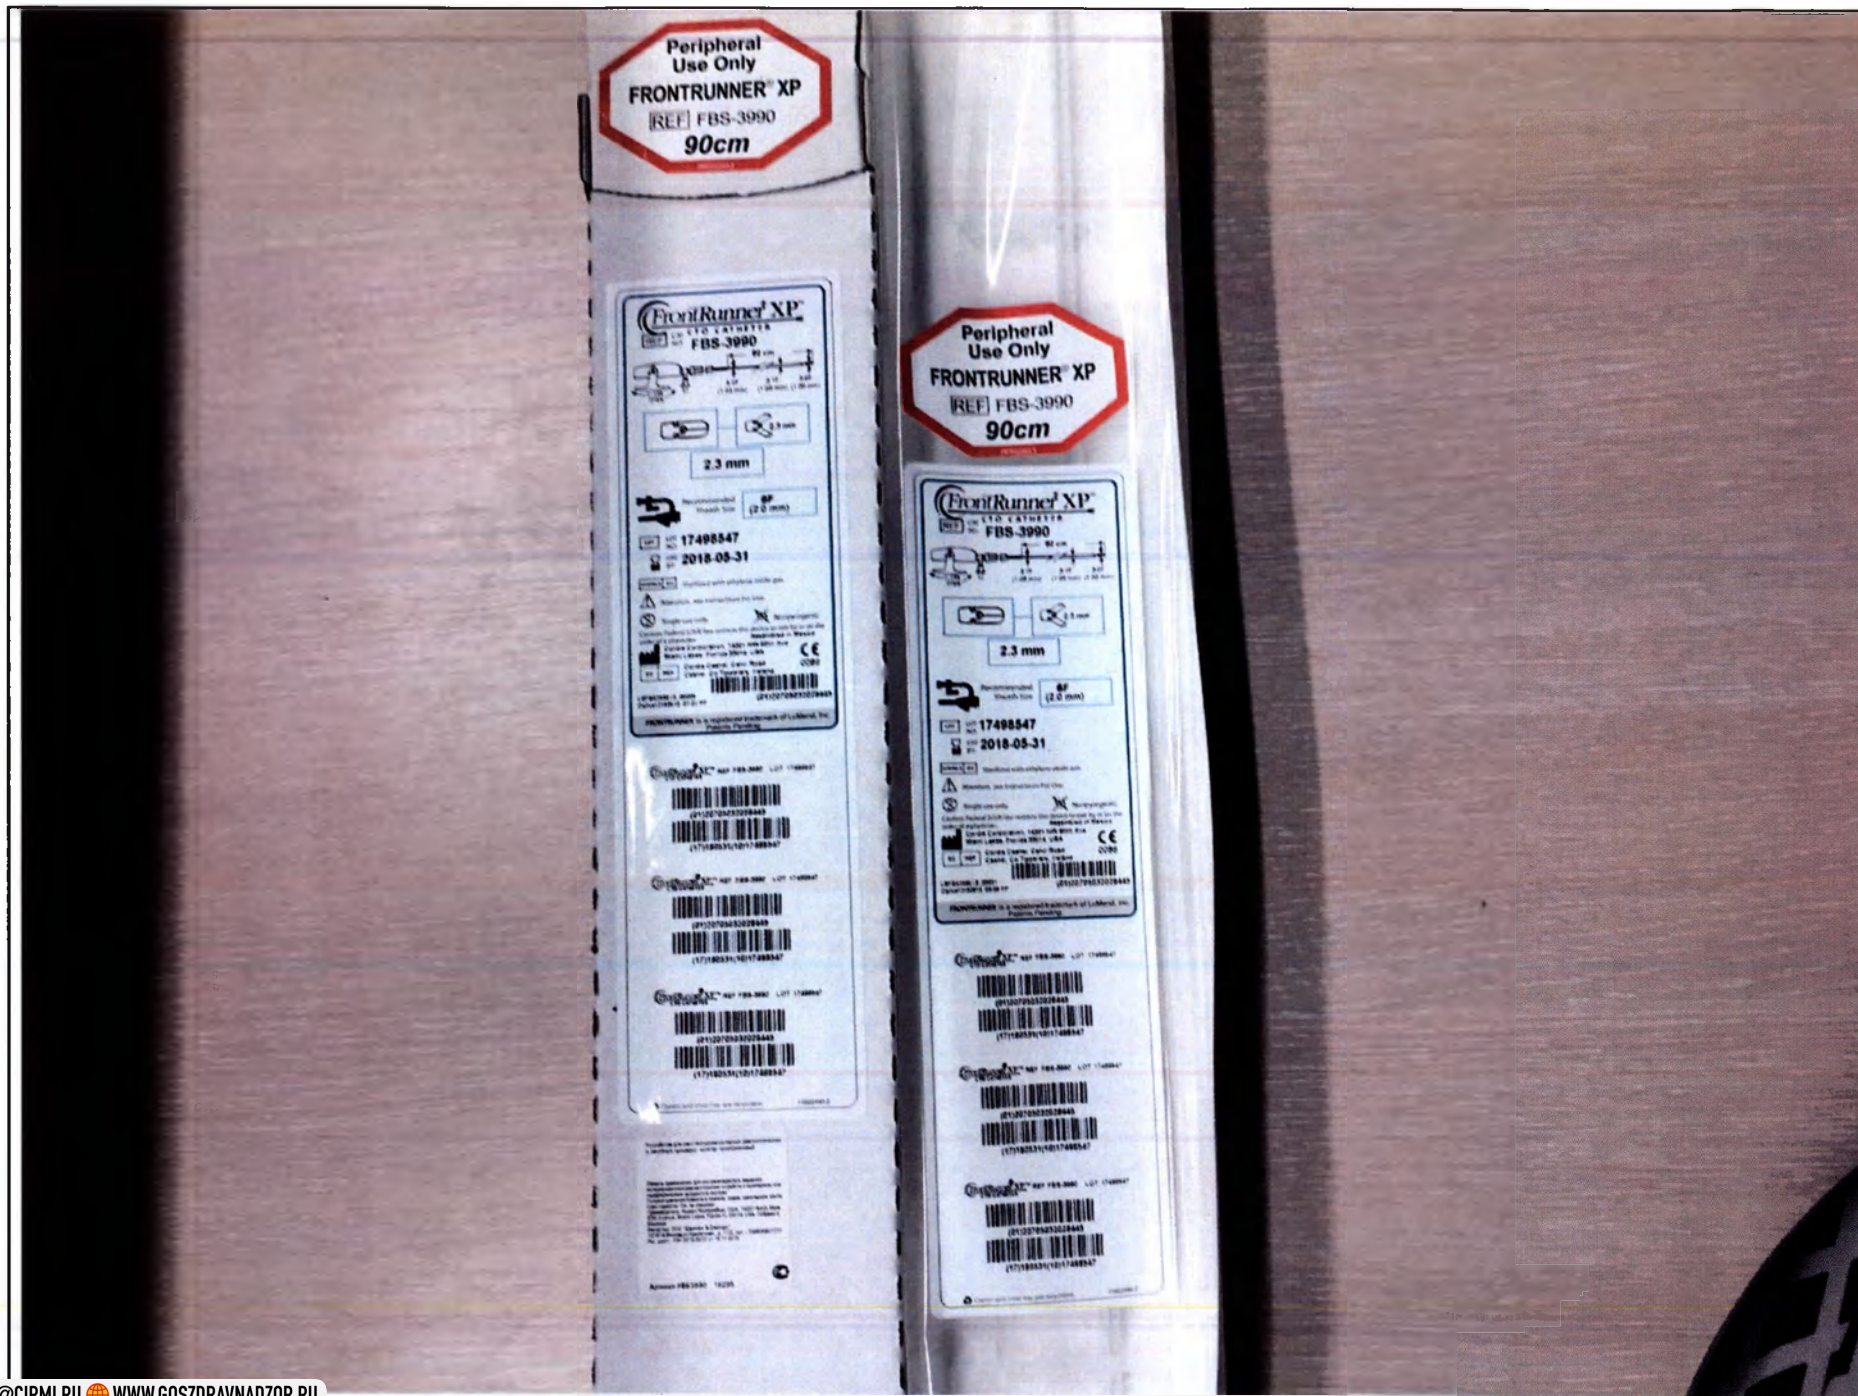

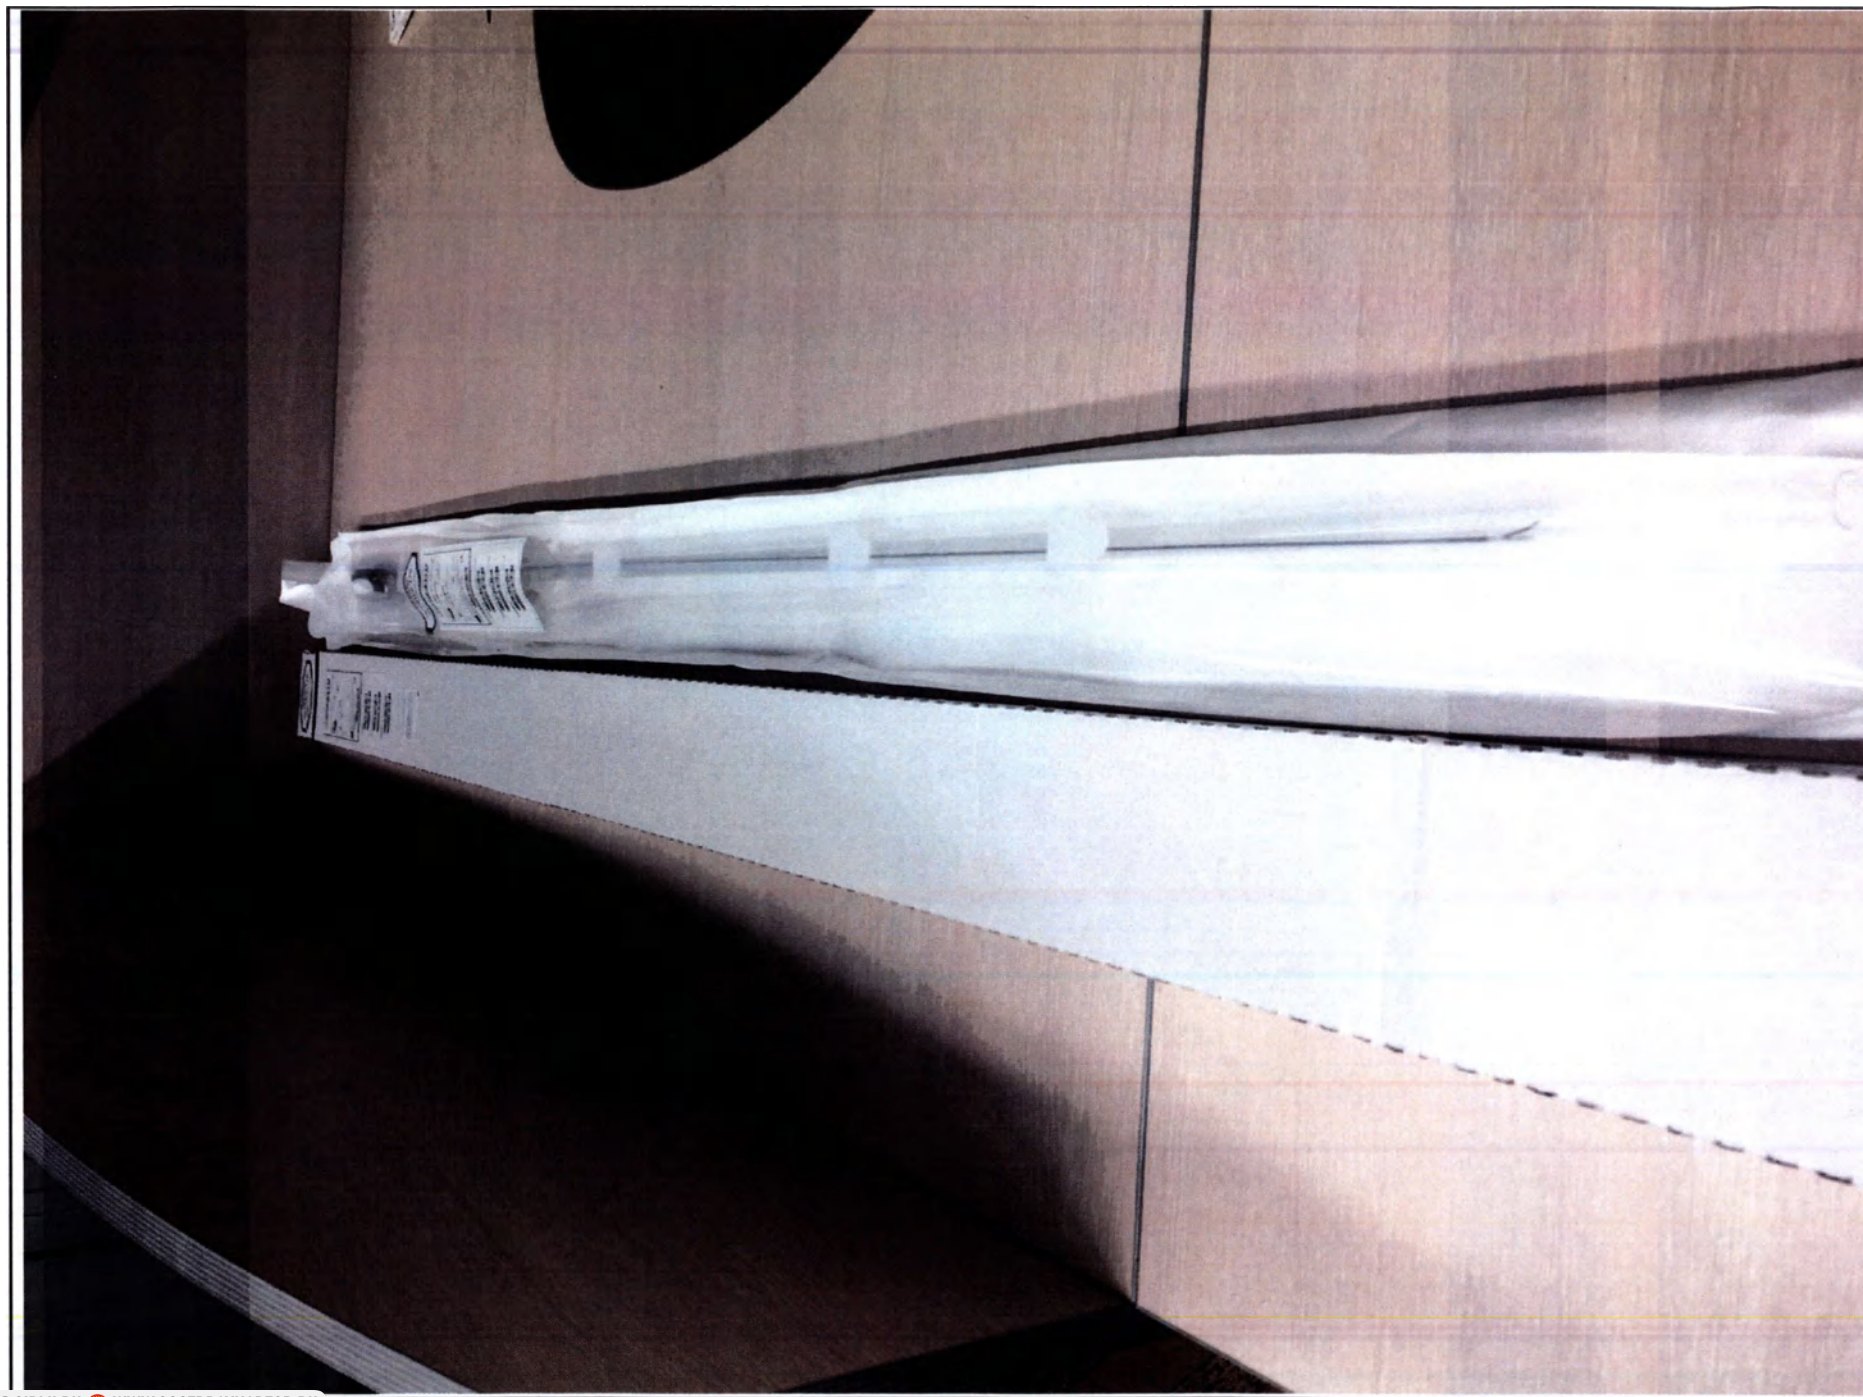

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: проводник

Область применения: для внутрисосудистого введения
интервенционных/диагностических устройств в коронарную или
периферическую сосудистую систему

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
80th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в


Мексике


Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул FBS3990 16266

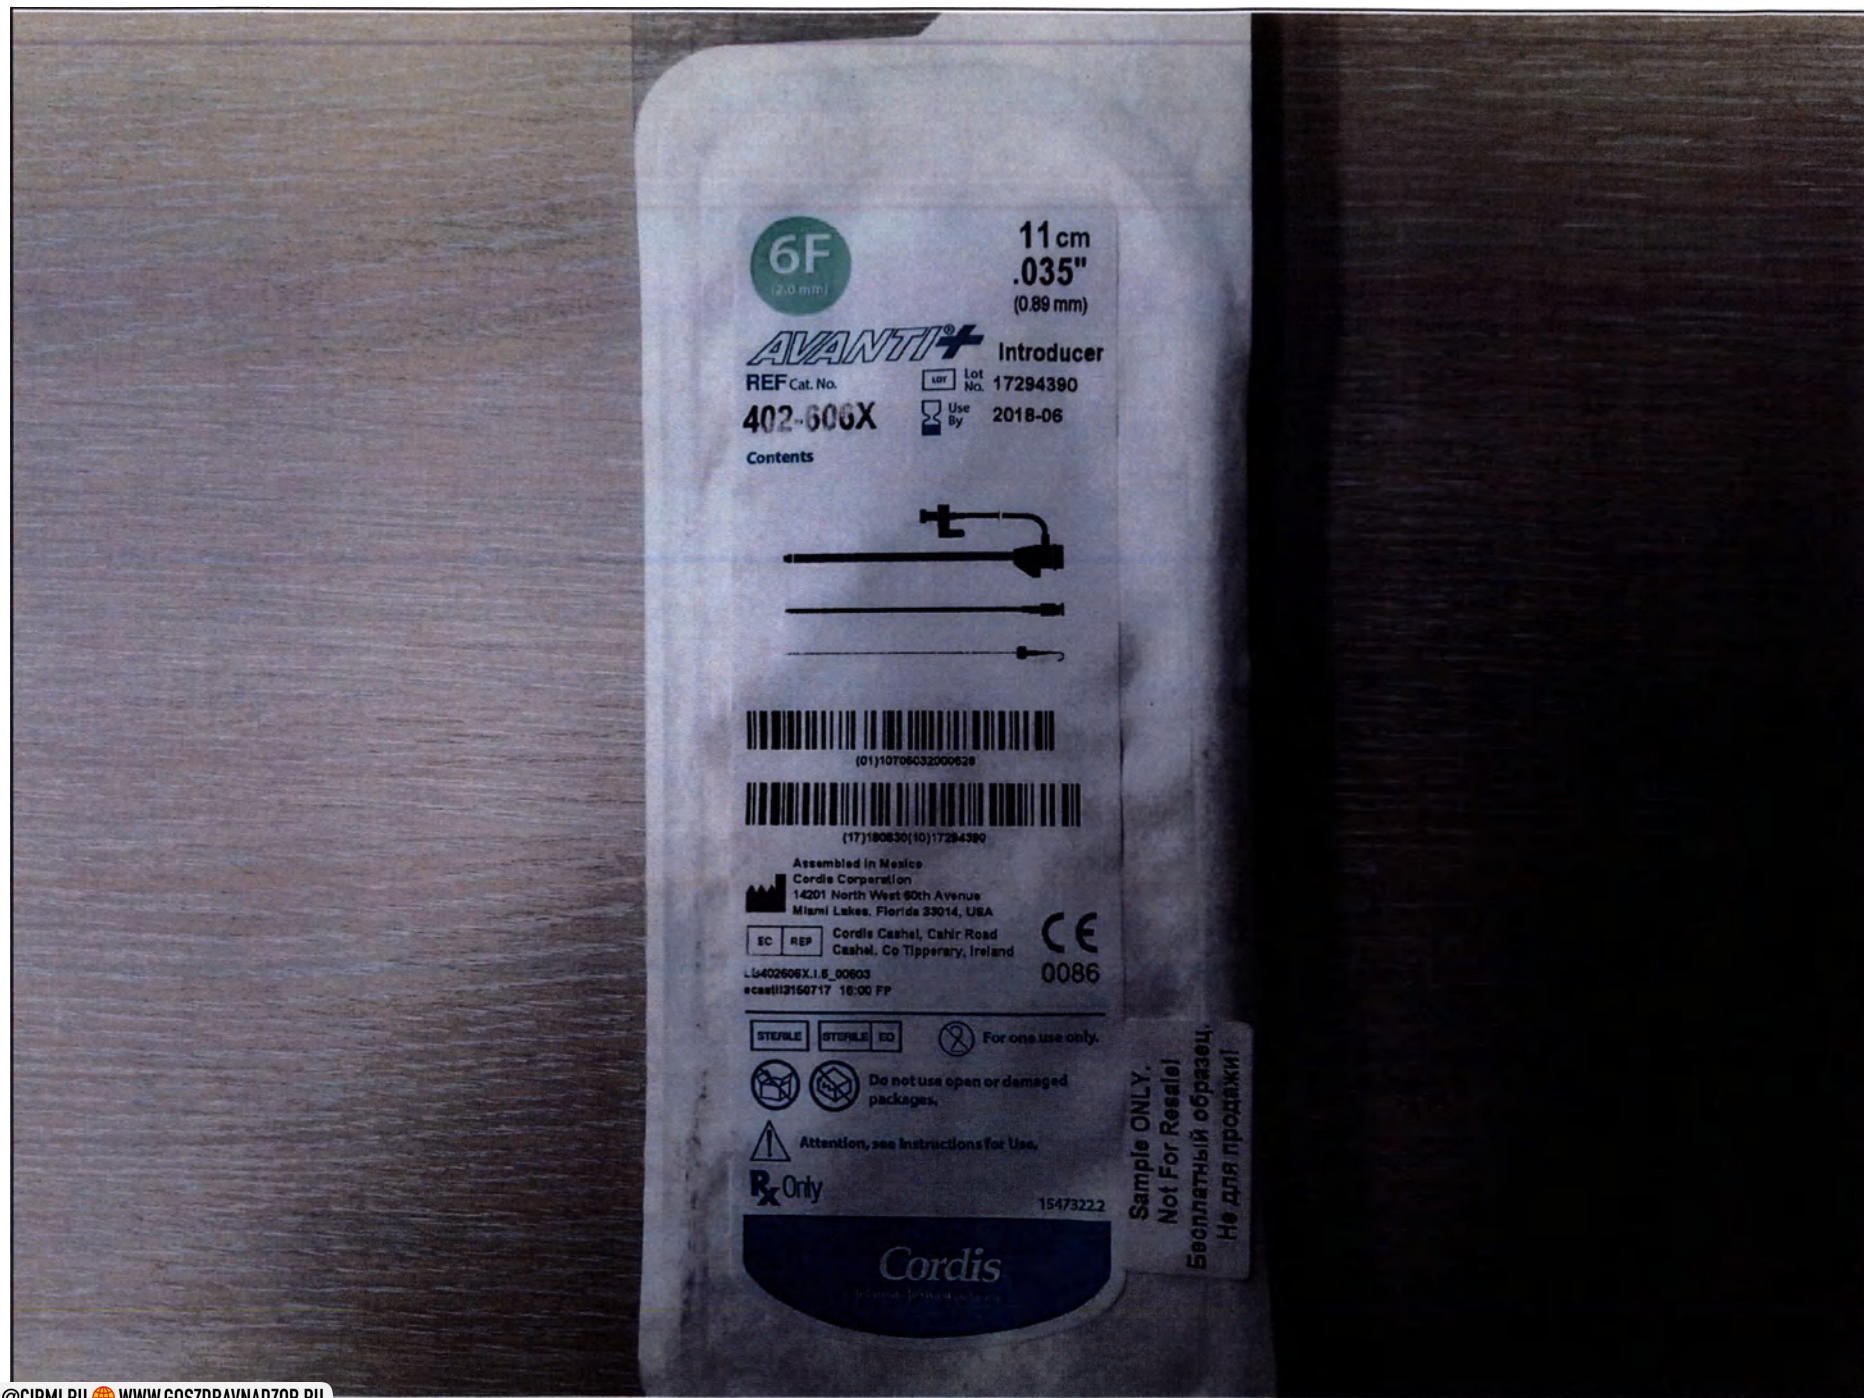




Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: интродьюсер


Область применения: В медицине
Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North W
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрать
Мексике
Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)580
Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015

Артикул 402606X 16306

Интердьюсер brite tip SHEATH

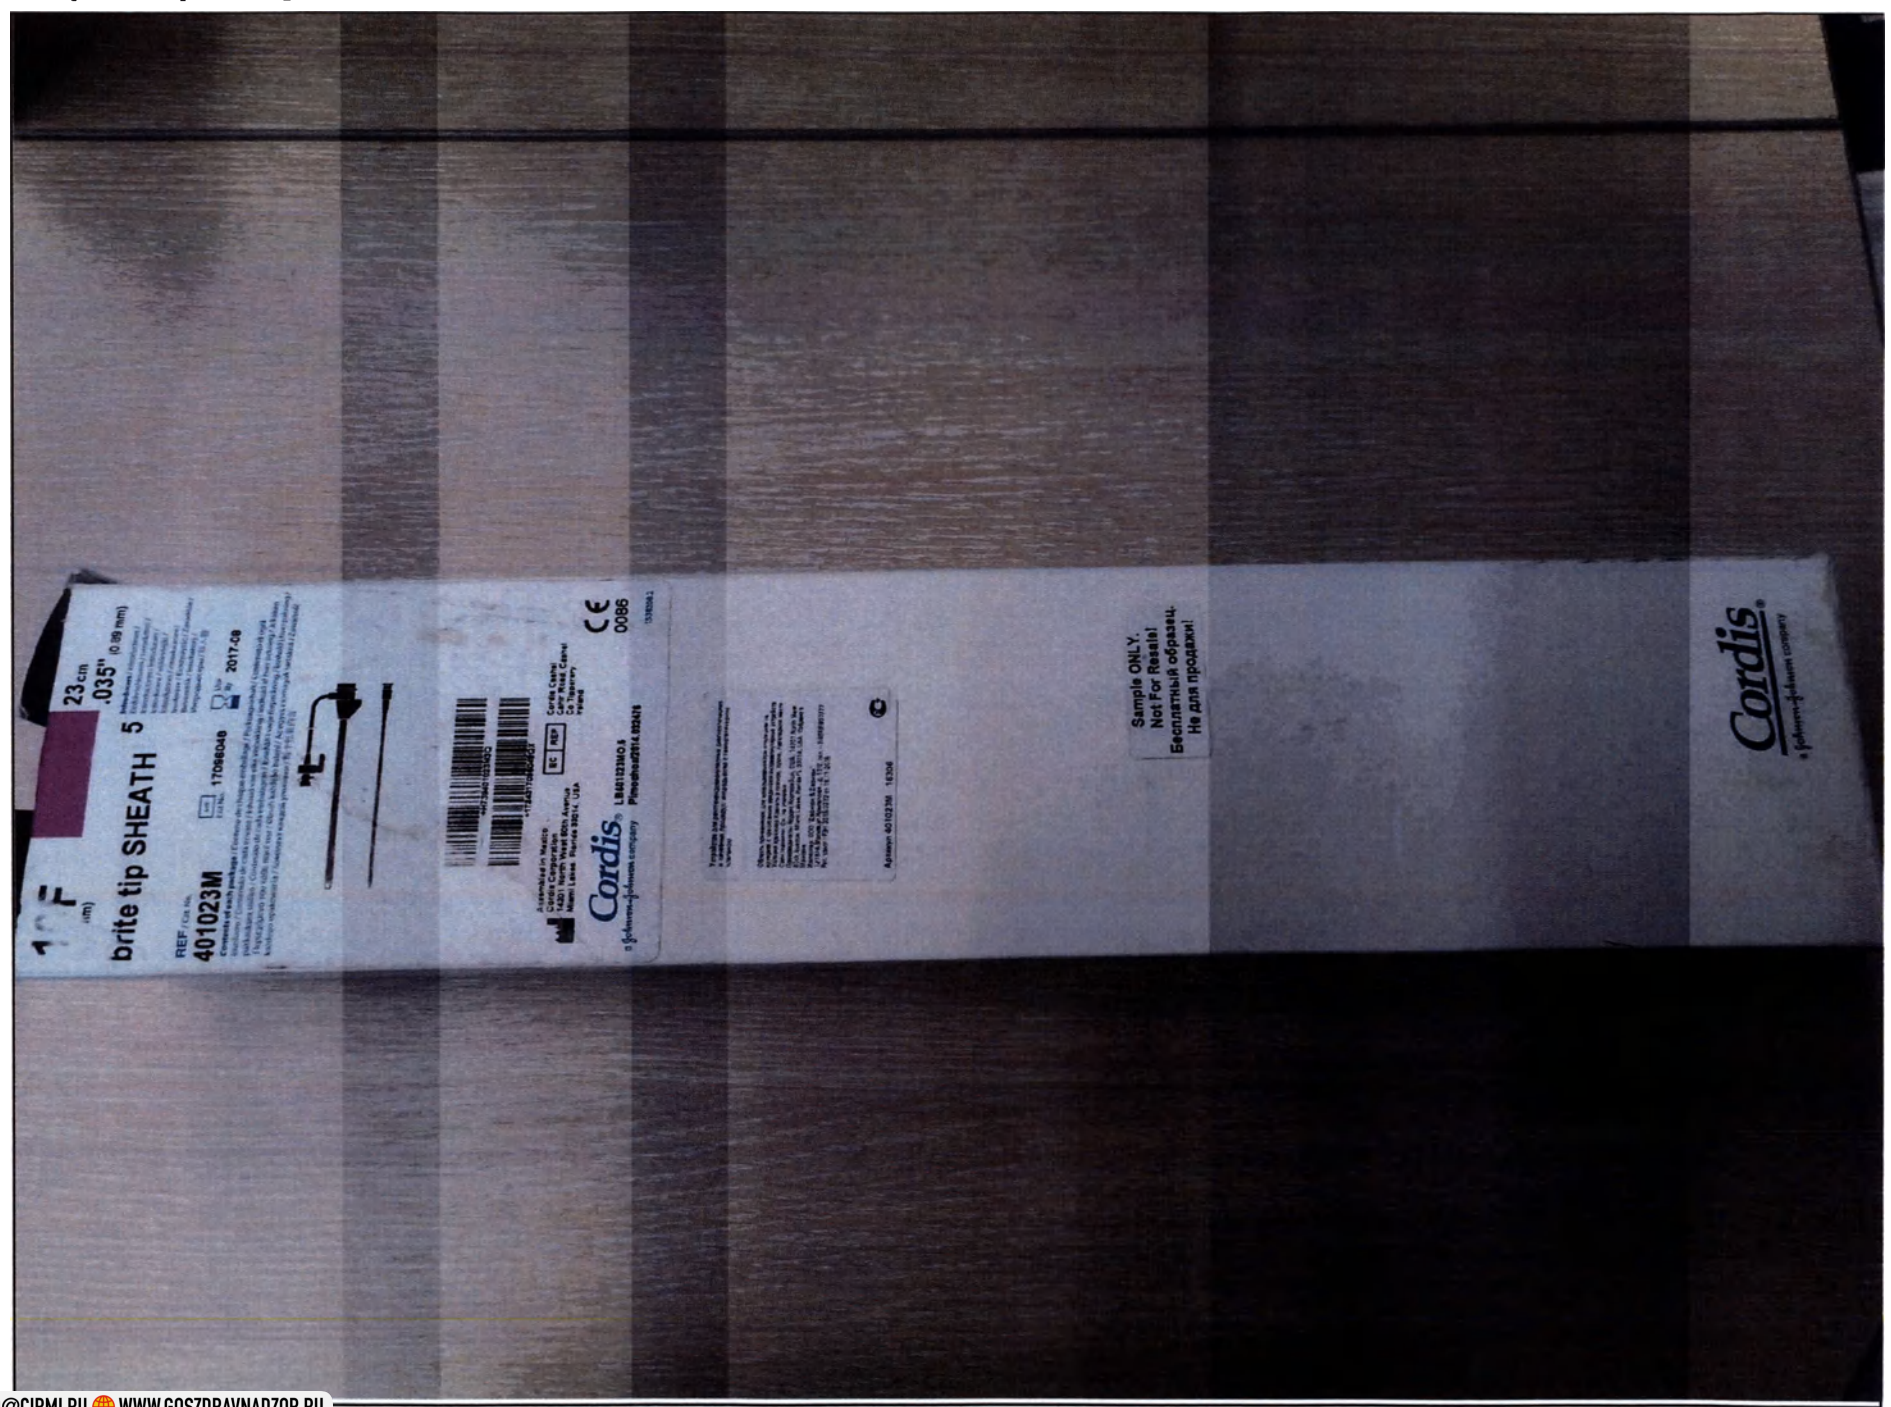

Интродьюсер brite tip SHEATH

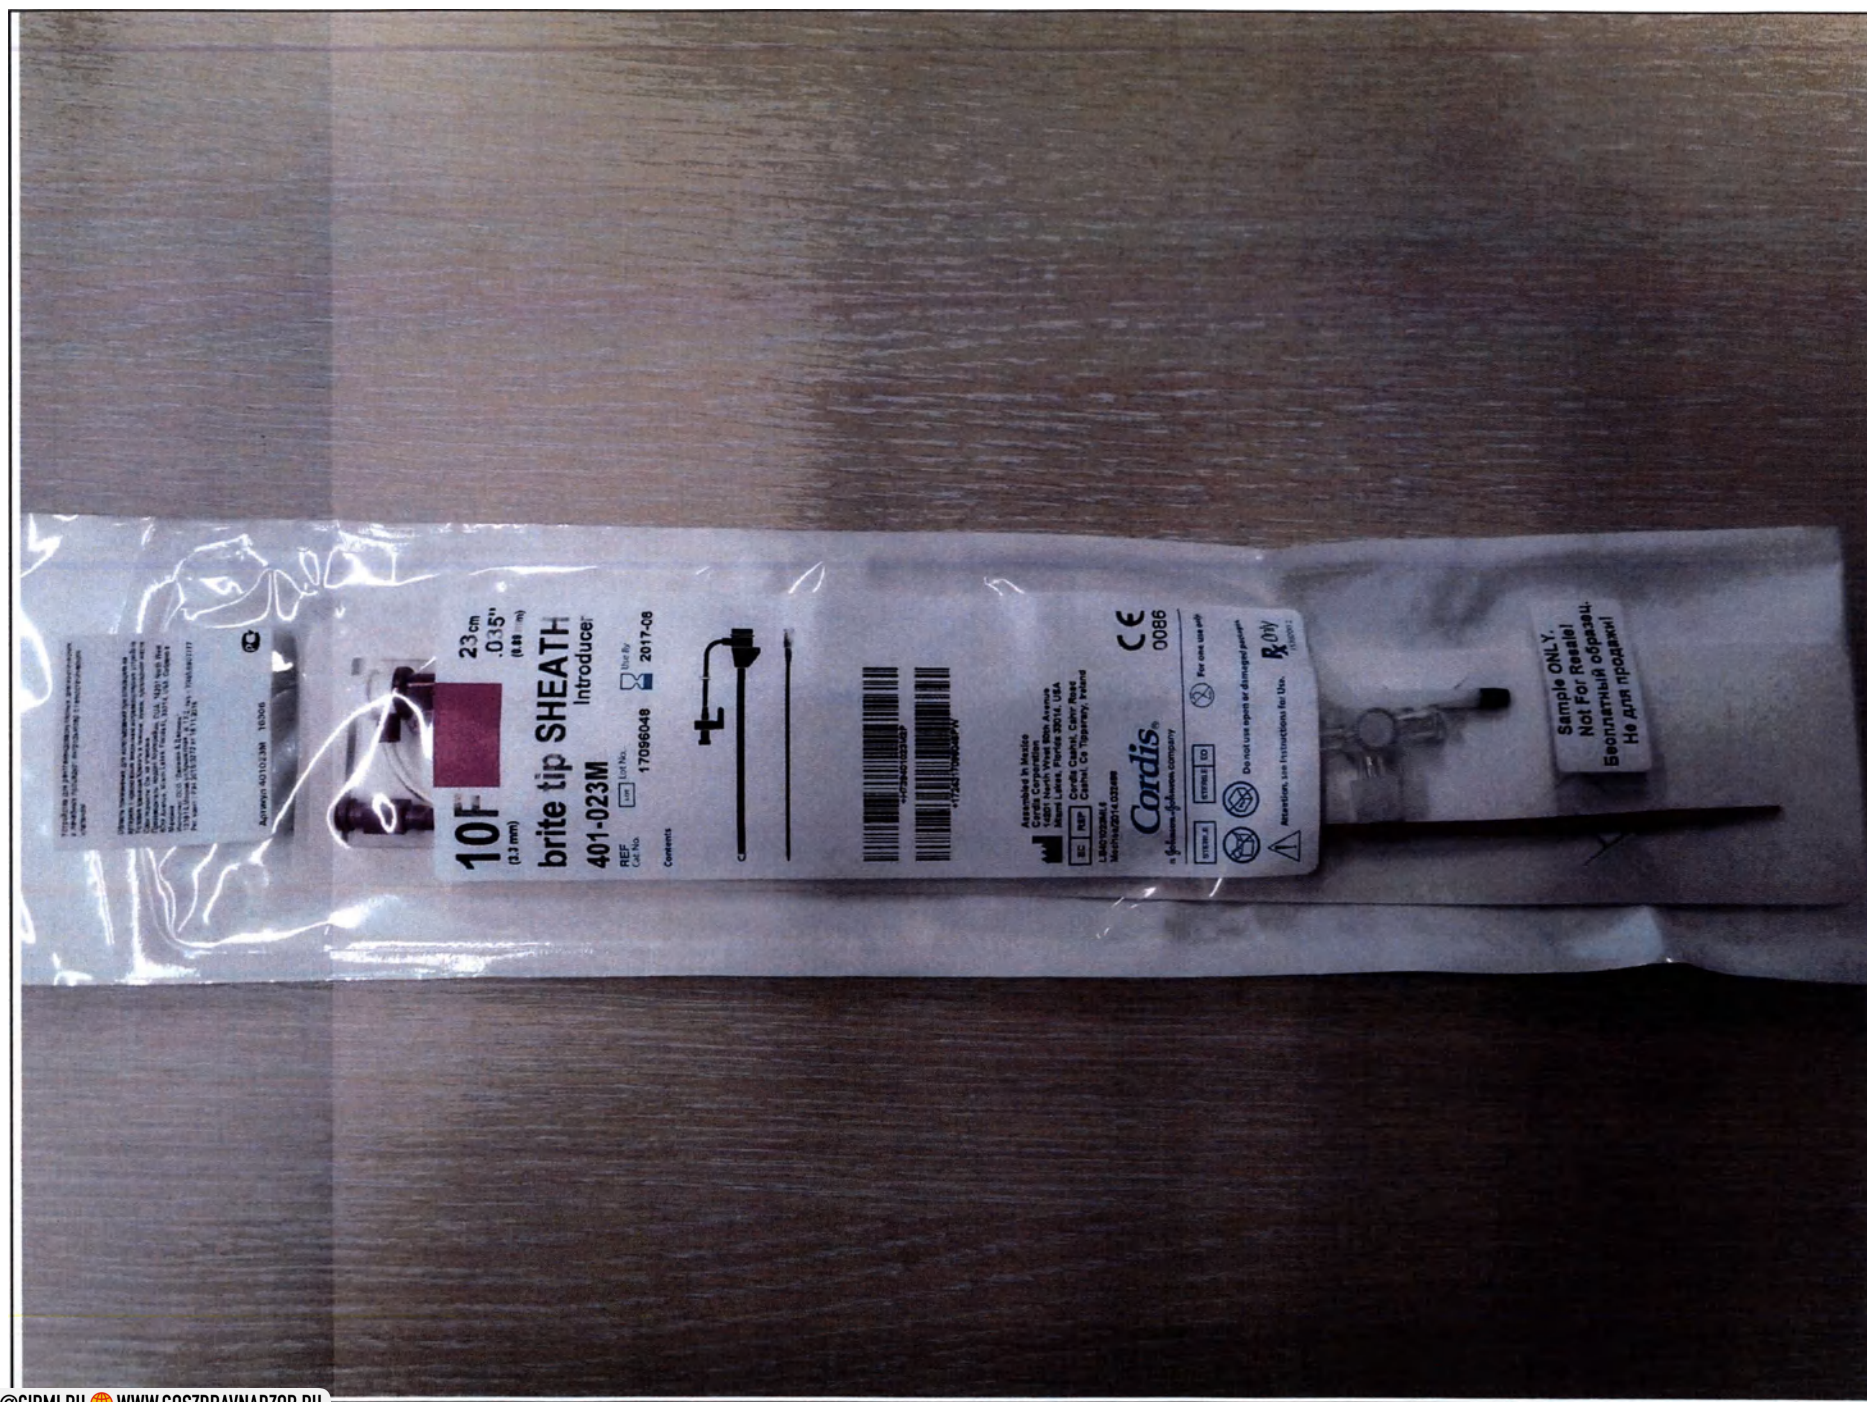

Johnson & Johnson®
Johnson company

LB401023MO.5

PIMOCHOA/2014.032476

Интродьюсер bite tip SHEATH

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: интродьюсер

Область применения: для использования при операциях на
артериях с чресножным введением интраваскулярных устройств

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"


121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 401023M 16306

Интродьюсеры LONG SHEATH Set

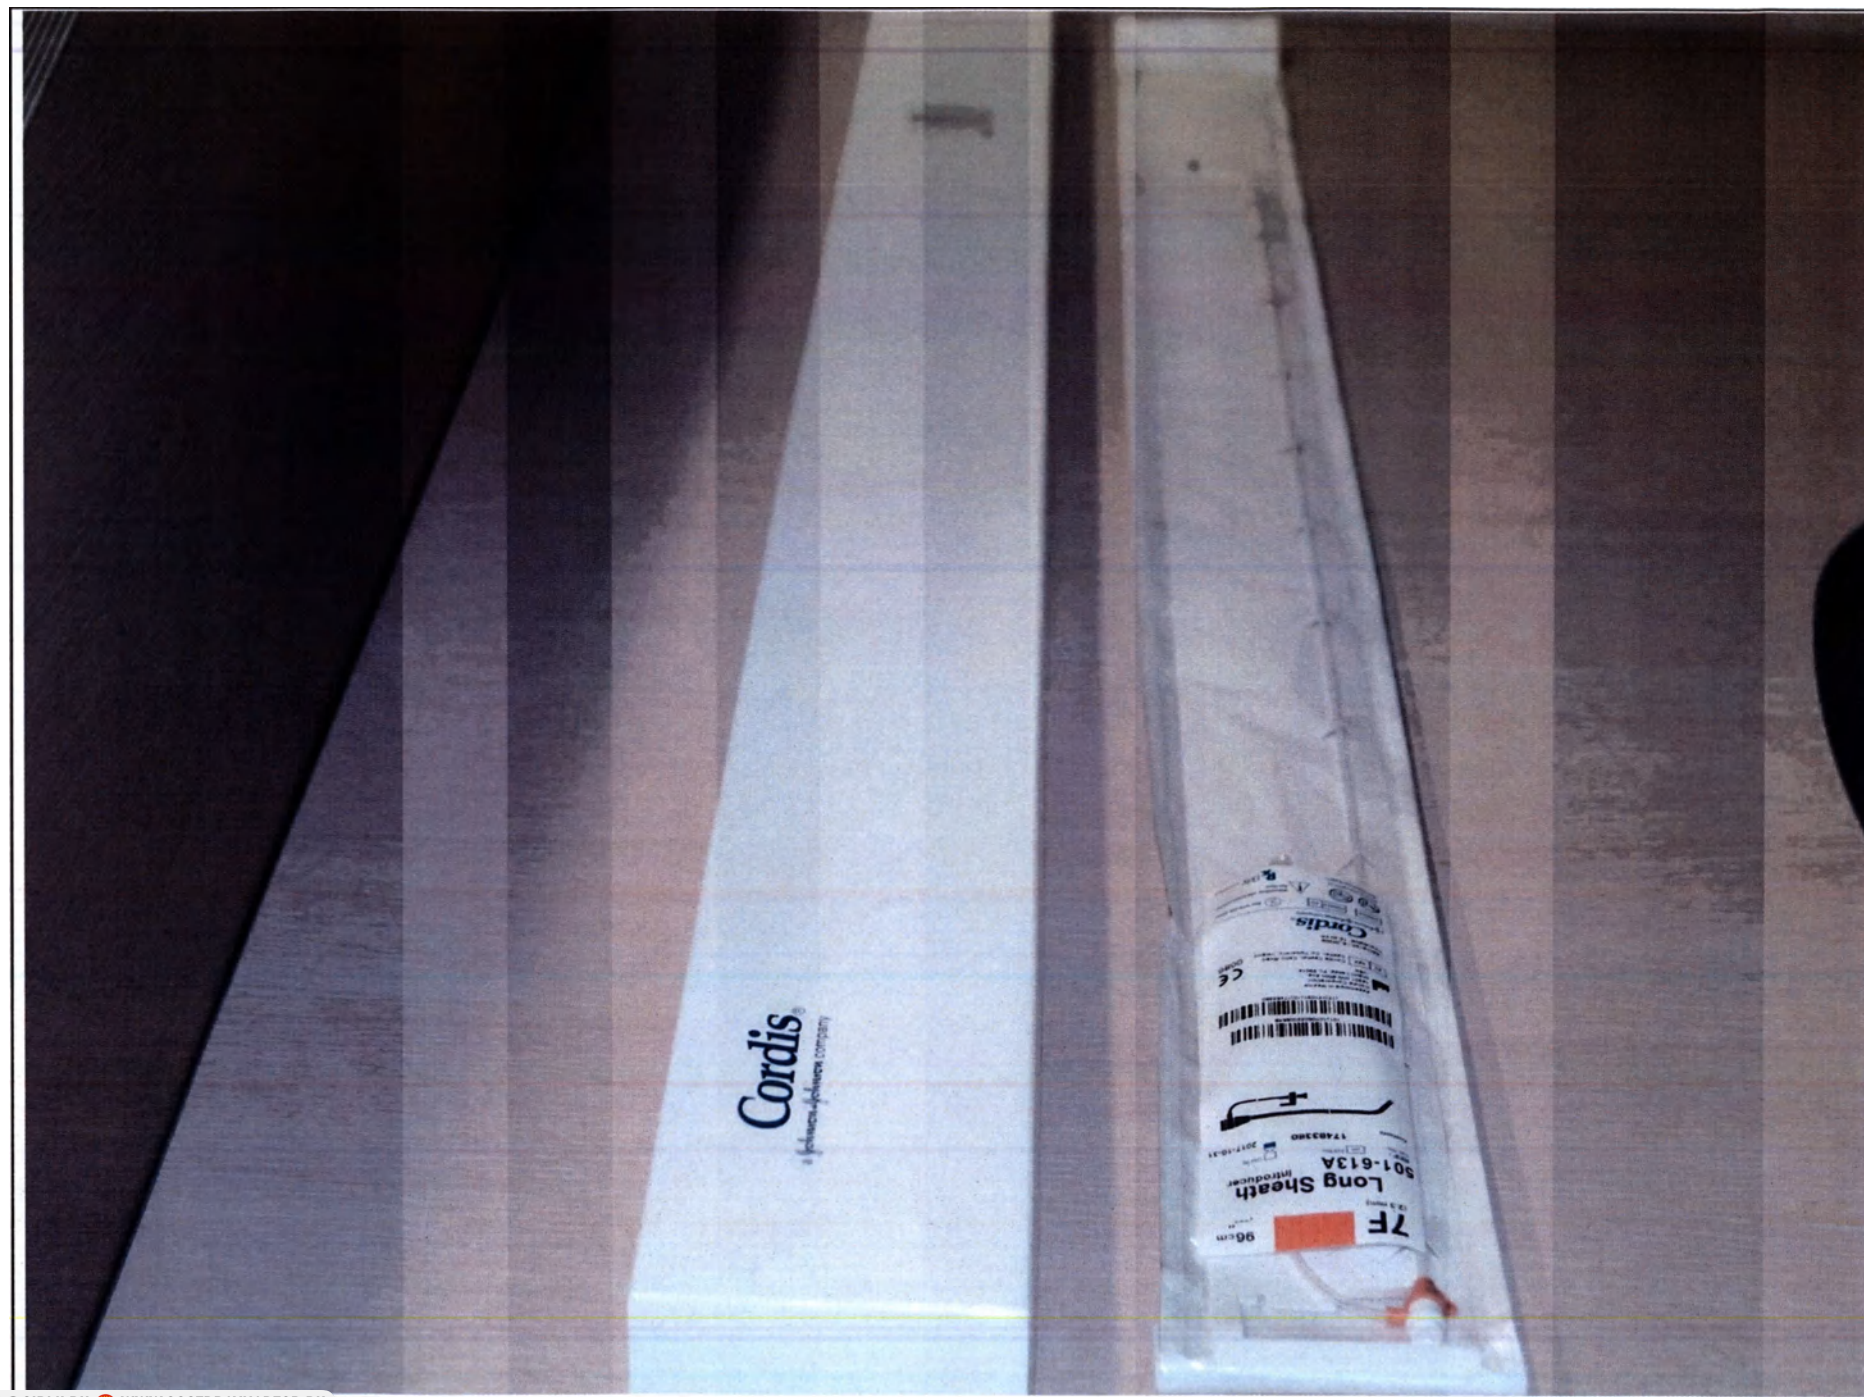



Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных процедур: интродьюсер

Область применения: для биопсии эндомиокарда

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Сделано в США

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 501613А



Cordis®
a Johnson & Johnson company

BI-PAL® 7

1 Torqueable / Formable / Disposable Biopsy Forceps.

REF 502-400B
Cat. No.

7 F (2.3 mm) 104 cm

Recommended Sheath

7 F
(2.3 mm)

Jaw Volume

5.03 mm³

LOT N0316317 Use By 2019-02-28
Exp. No.



(01)10706032064842



(17)190228(12)N0316317

Cordis Corporation
14201 North West 60th Avenue
Miami Lakes, Florida 33014, USA

EC REP Cordis Cashel, Cahill Road
Cashel, Co Tipperary, Ireland

LB502400B.1.3_00019
anorria5160329 09 41 FP

CE
0086

1319498.3

**Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: щипцы биопсийные**

Область применения: для биопсии эндомиокарда

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Сделано в
США

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.

Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 502400В 16357

BIOPSY FORCEPS  REF 504-302L
70616262  2019-05

[illegible]

7F
(2.5 mm)

50 cm

Recommended bleach: Sodium hypochlorite (1) / Potassium hypochlorite (2)
Intermittent spraying: Sodium hypochlorite (3) / Sodium hypochlorite (4)
Continuous spray: Sodium hypochlorite (5) / Potassium hypochlorite (6)
Antibacterial spray: Sodium hypochlorite (7) / Potassium hypochlorite (8)

5.20 mm



(01)20706032066127(17)19063110170618262


CE 0086 EC REP Cahir Rd. Goshel Co Tipperary, Ireland Cordis Johnson & Johnson Corporation 14201 North West 50th Avenue

9547294 3 Miami Lakes, Florida 33014 USA

Cordis®

a Johnson & Johnson company

Щипцы биопсийные BIOPSY FORCEPS

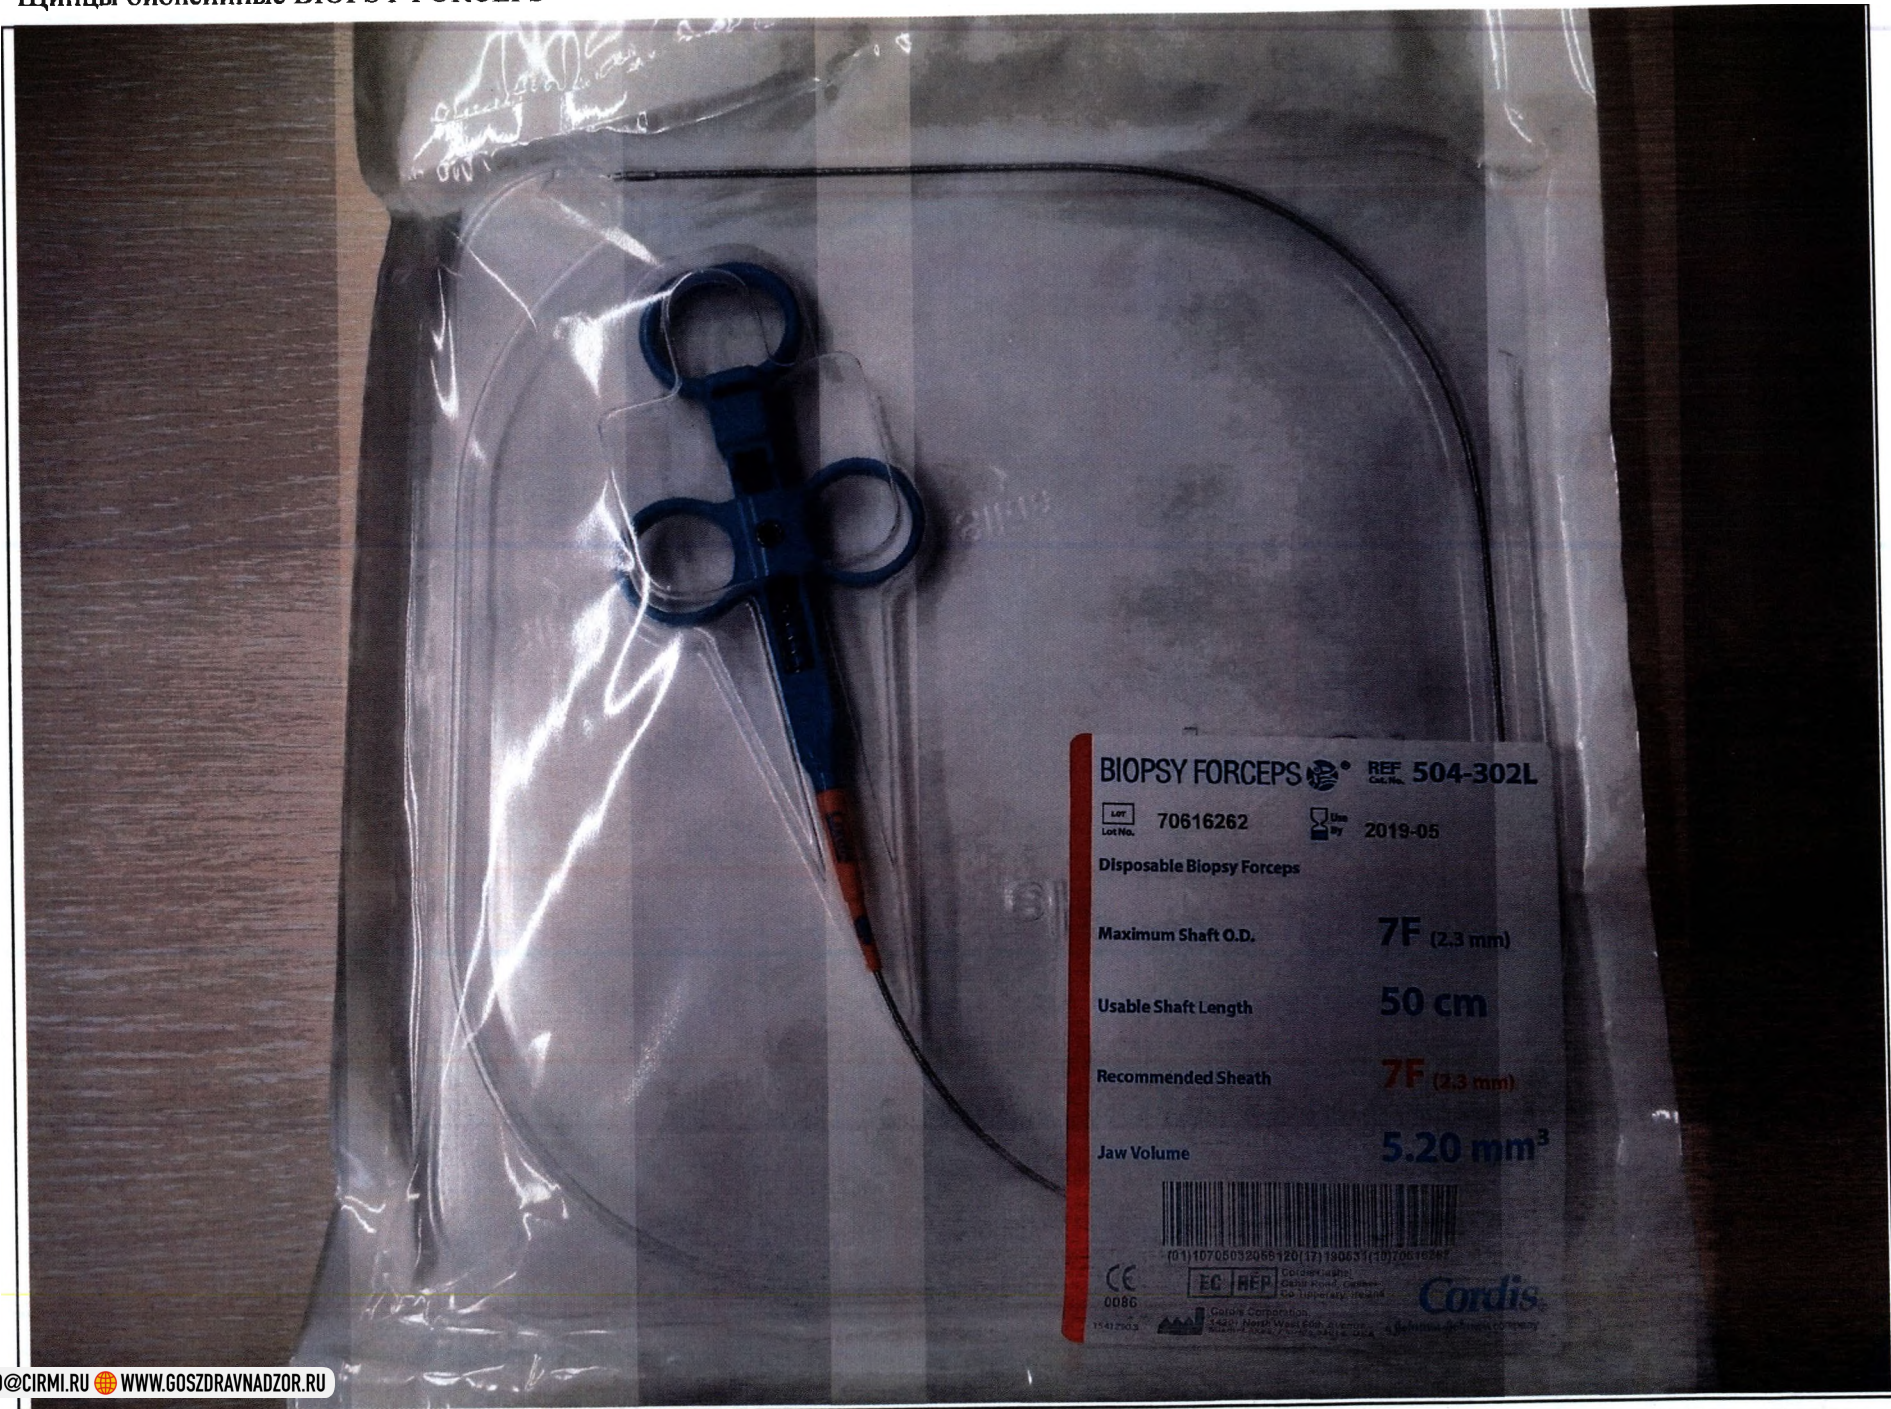

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: шипцы биопсийные

Область применения: для биопсии эндомиокарда

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Сделано в
США

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 504302L 16266

Диллятор


Область применения: Хирургия
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°.
Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не
использовать после истечения срока хранения.
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: См. на упаковке
Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777
Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 504404X



Дилятор/Обтуратор Vessel Dilators/Obturator

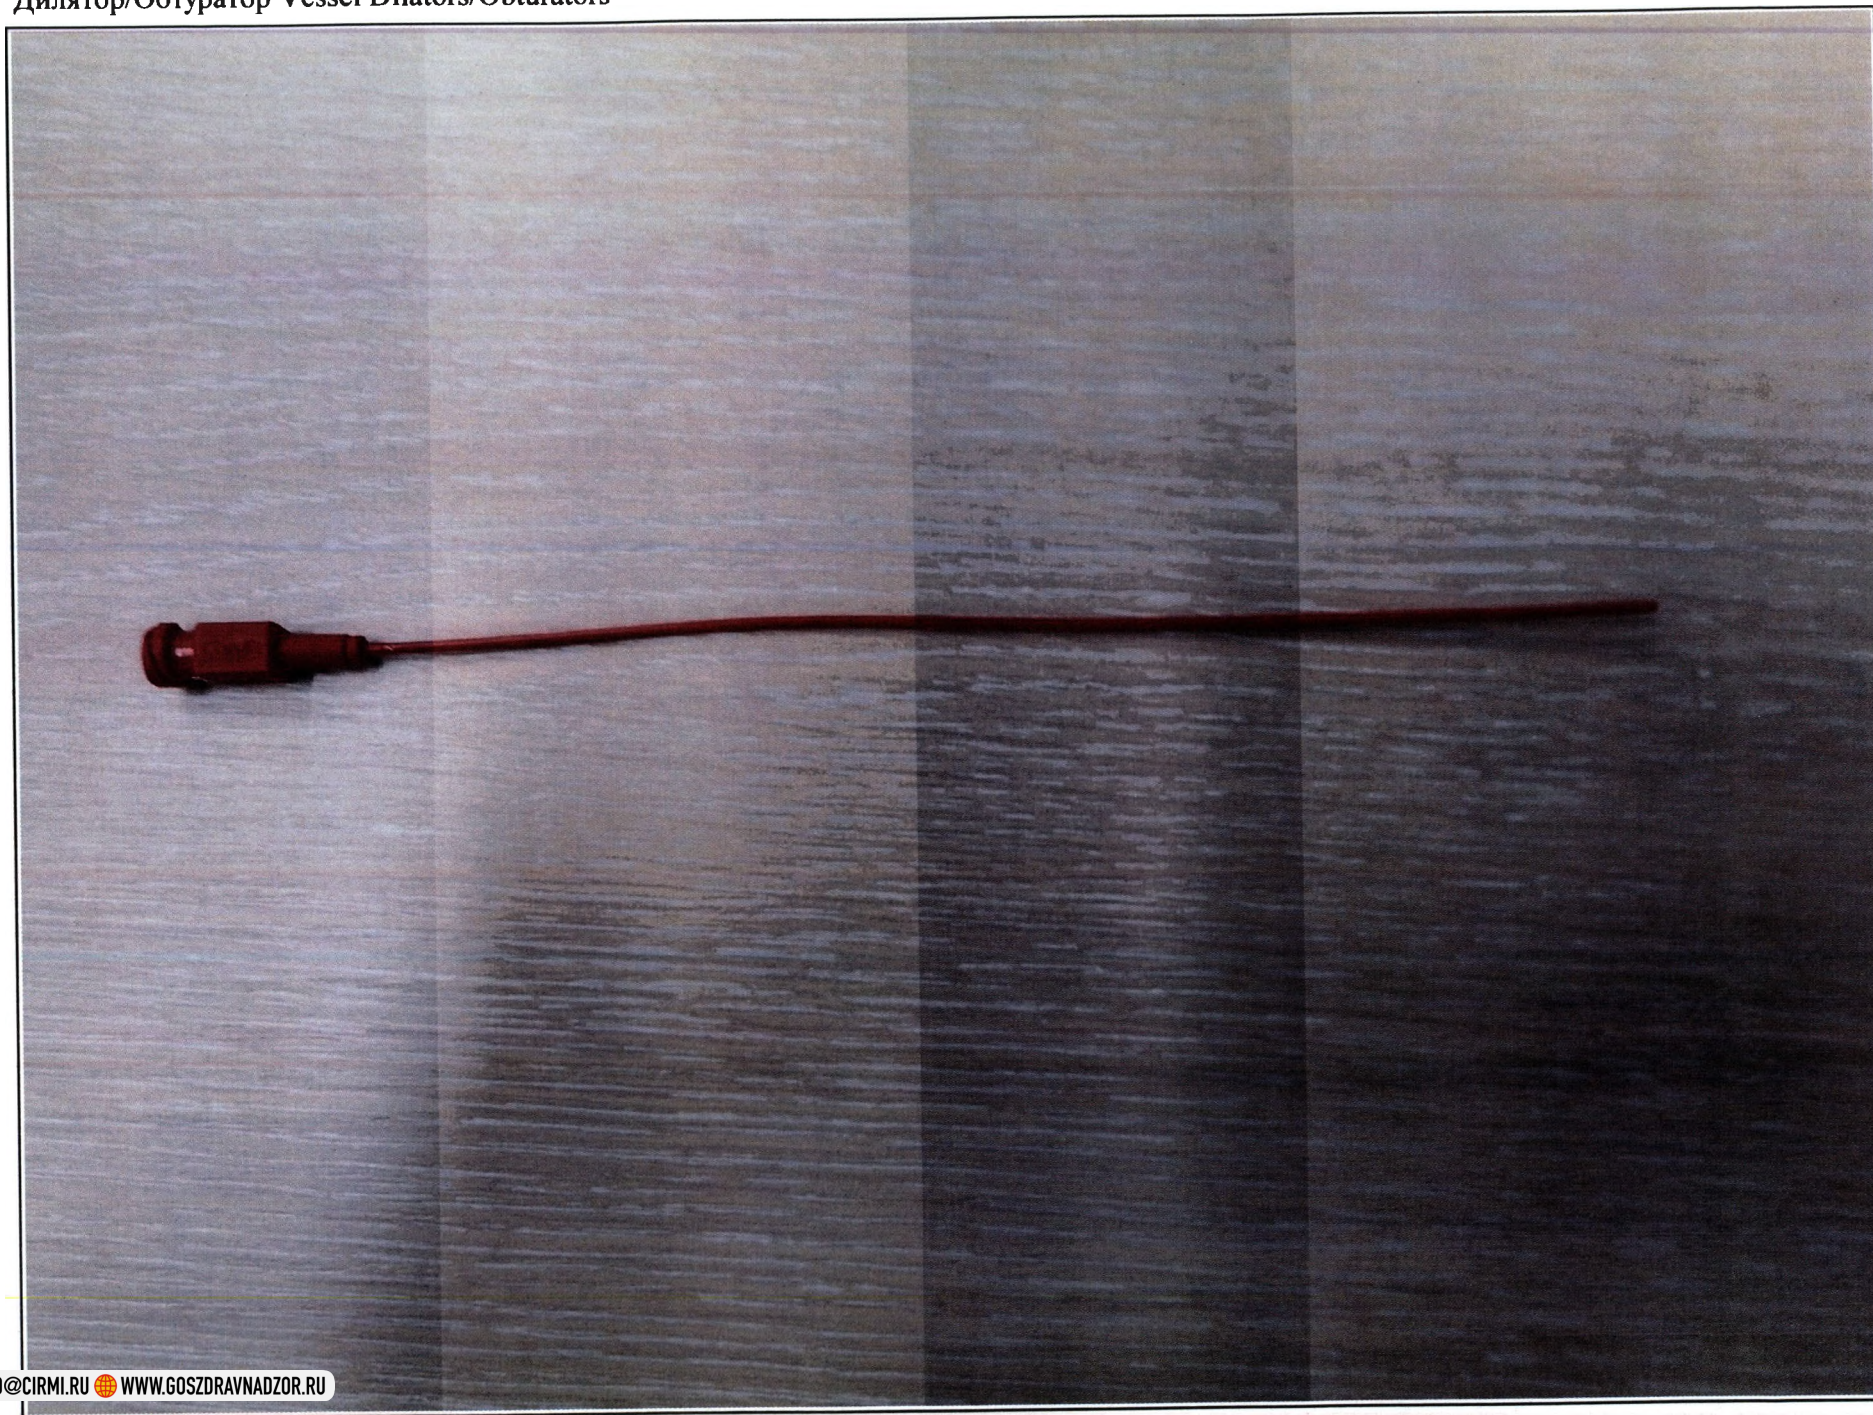


Обтуратор


Область применения: Хирургия
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°.
Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не
использовать после истечения срока хранения.
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: См. на упаковке
Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. +7(495)5907777
Рег. удет.: РЗН 2015/3272 от 18.11.2015



Артикул 502188 16340

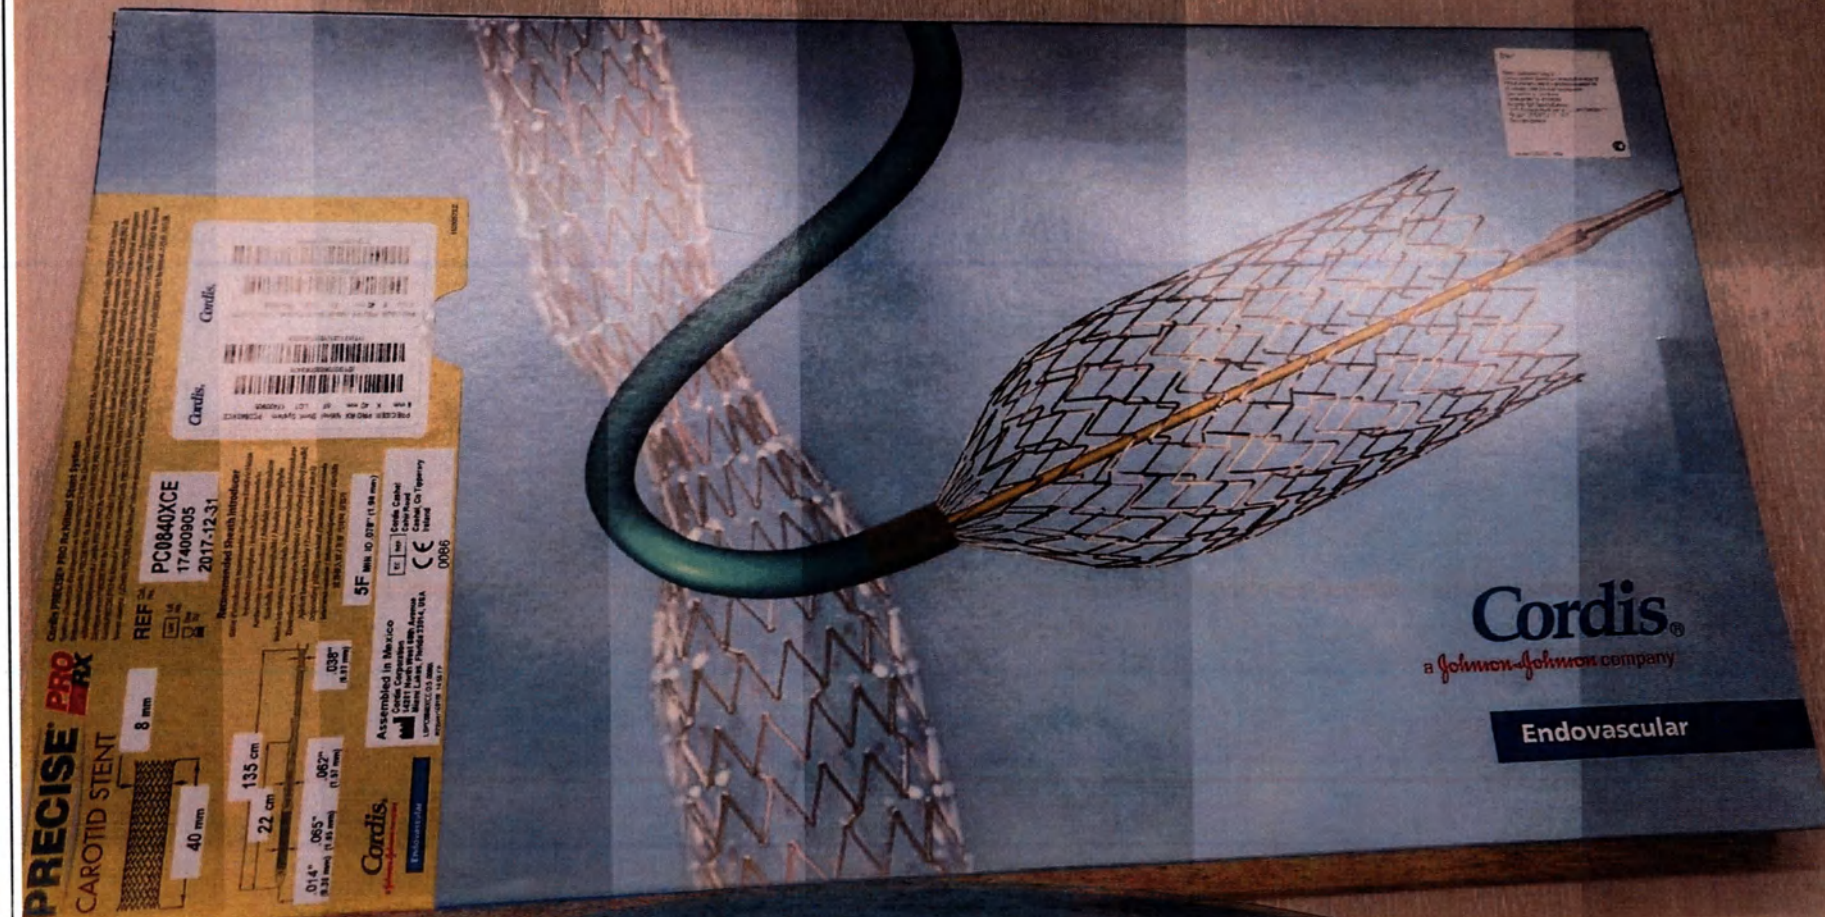

Стенты PRECISE PRO RX

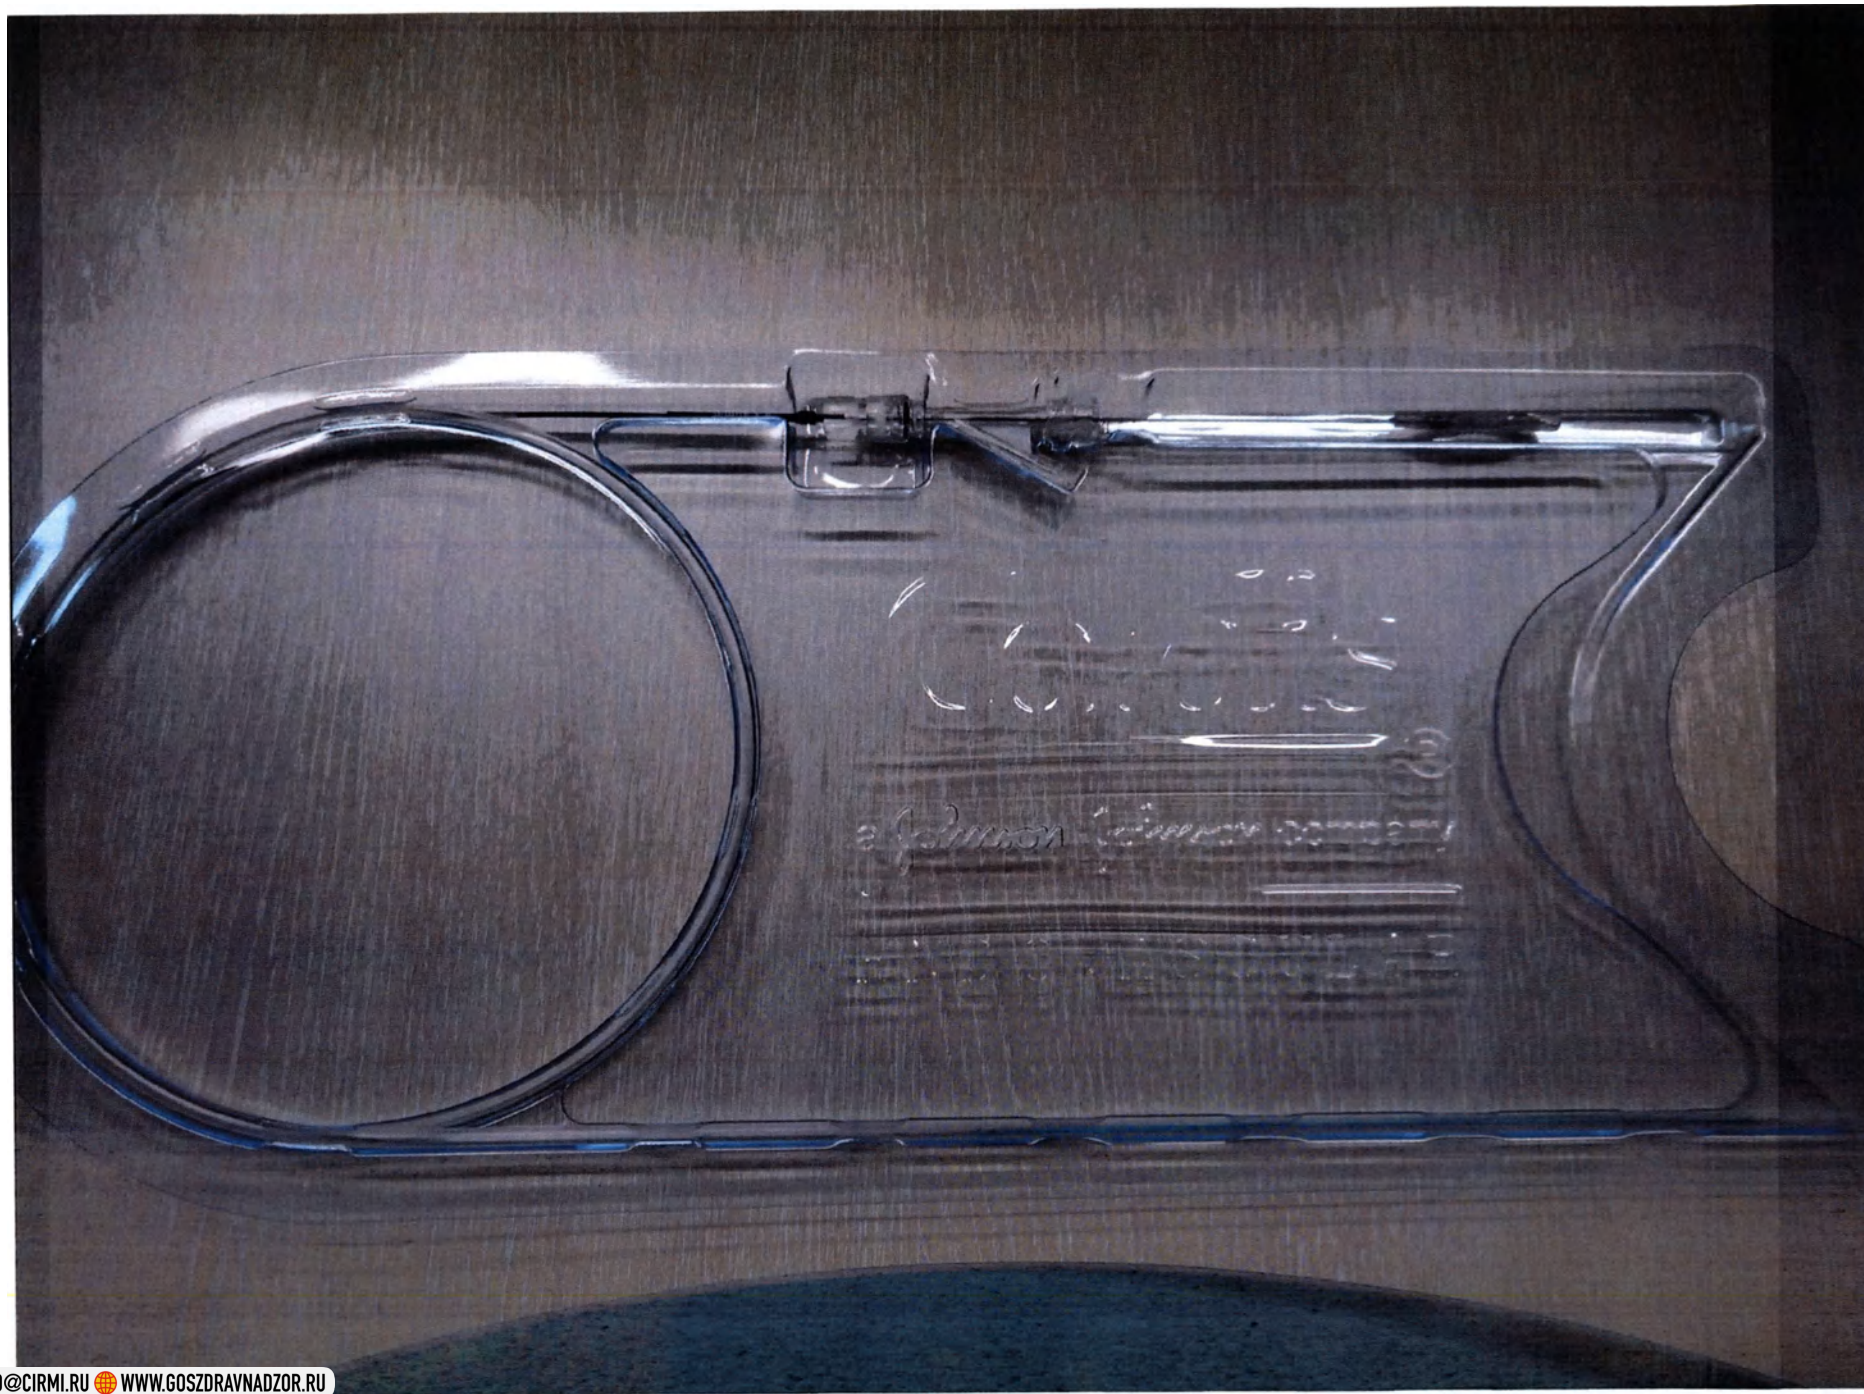

Стент

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°

Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не использовать после истечения срока хранения

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: См. на упаковке

Импортёр: ООО "Джонсон&Джонсон"


121614 Москва ул Крылатская, д. 17/2 тел. +7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3272 от 16.11.2015

Орган сертификации: -





Артикул PC0840XOE 16099

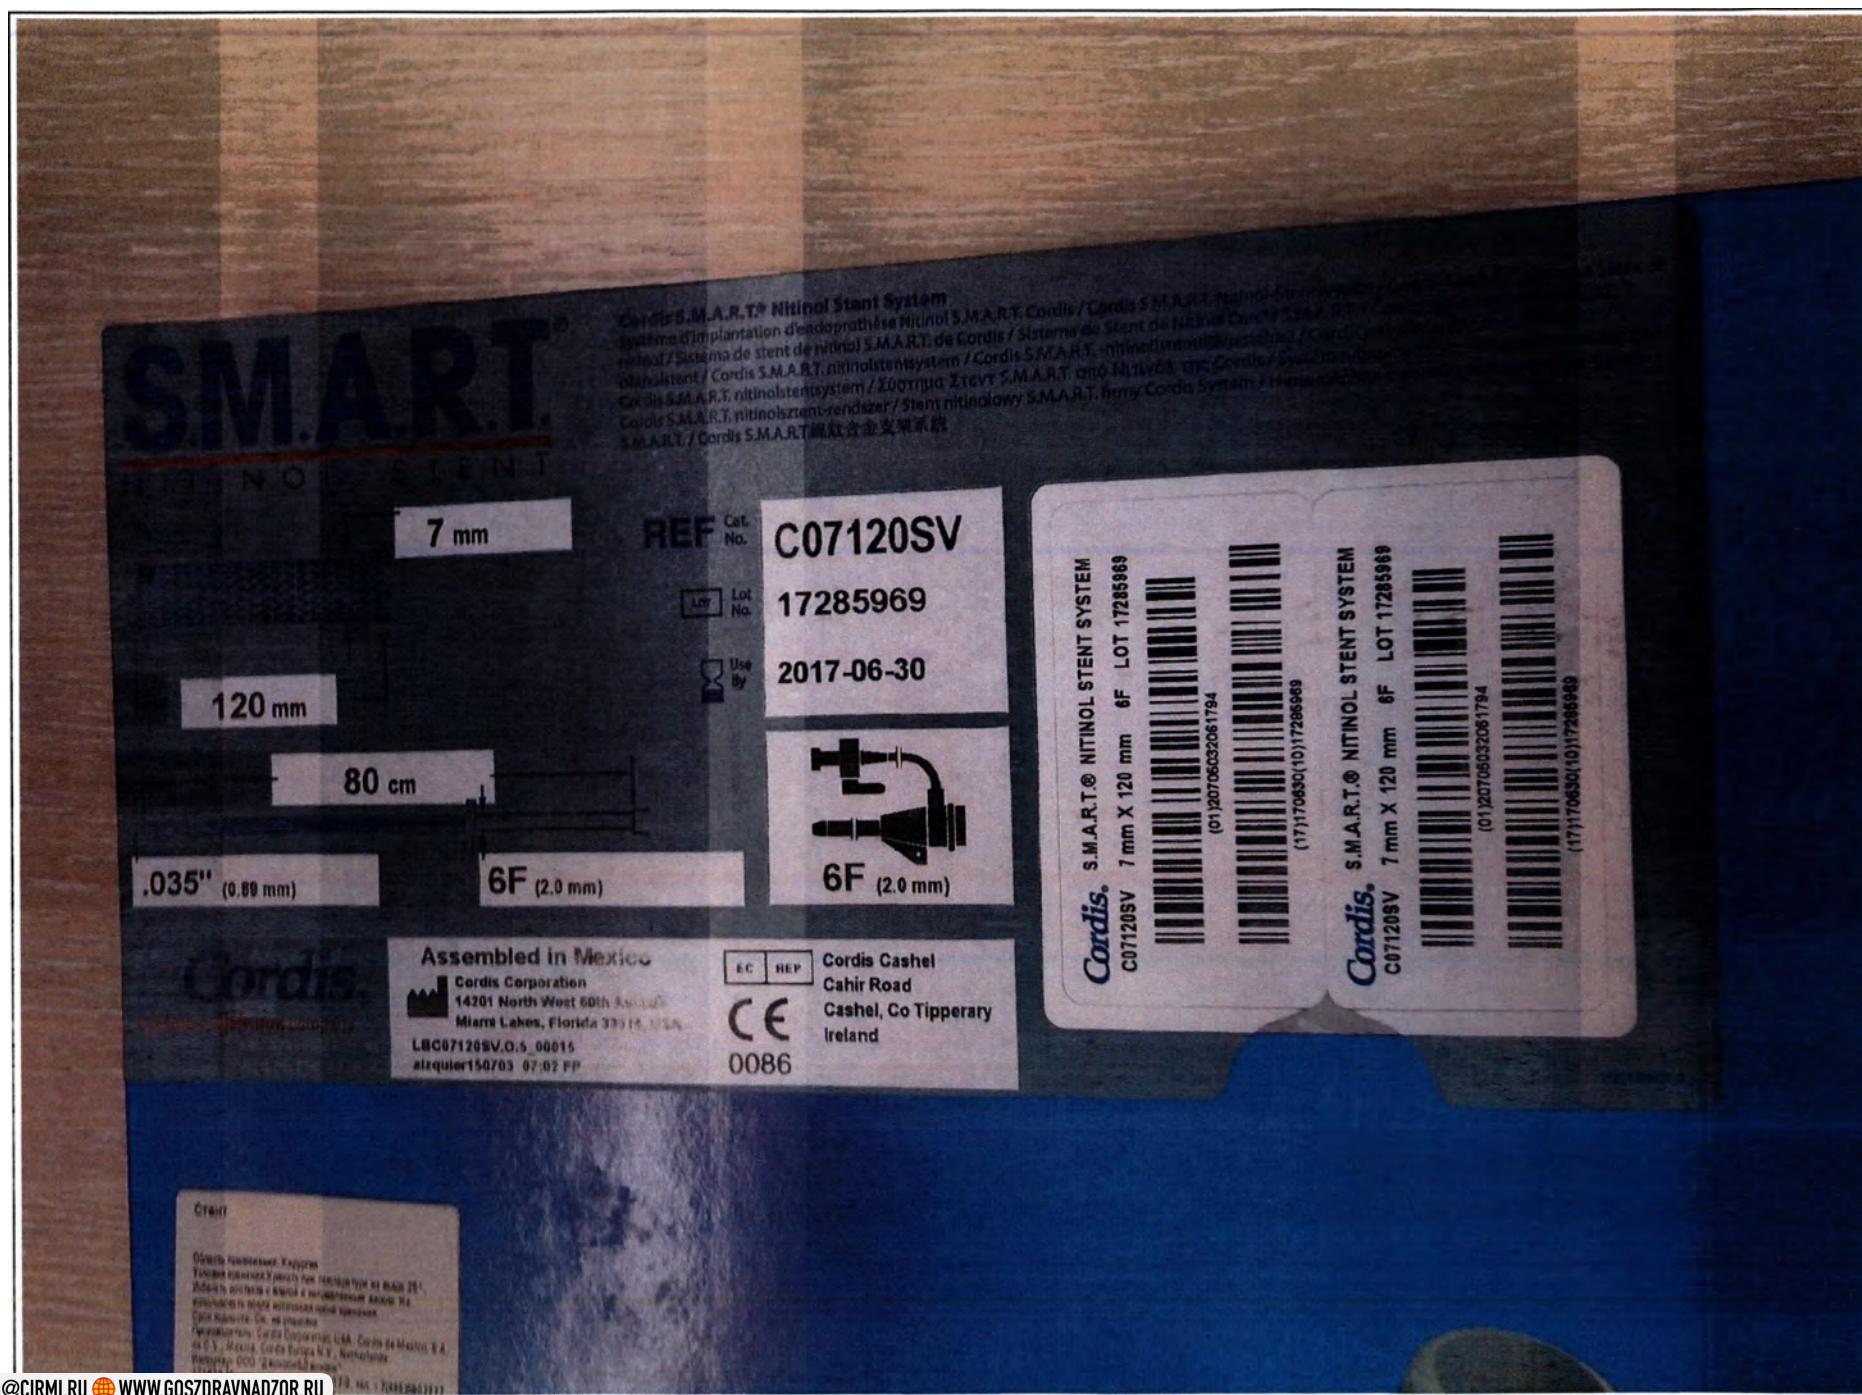





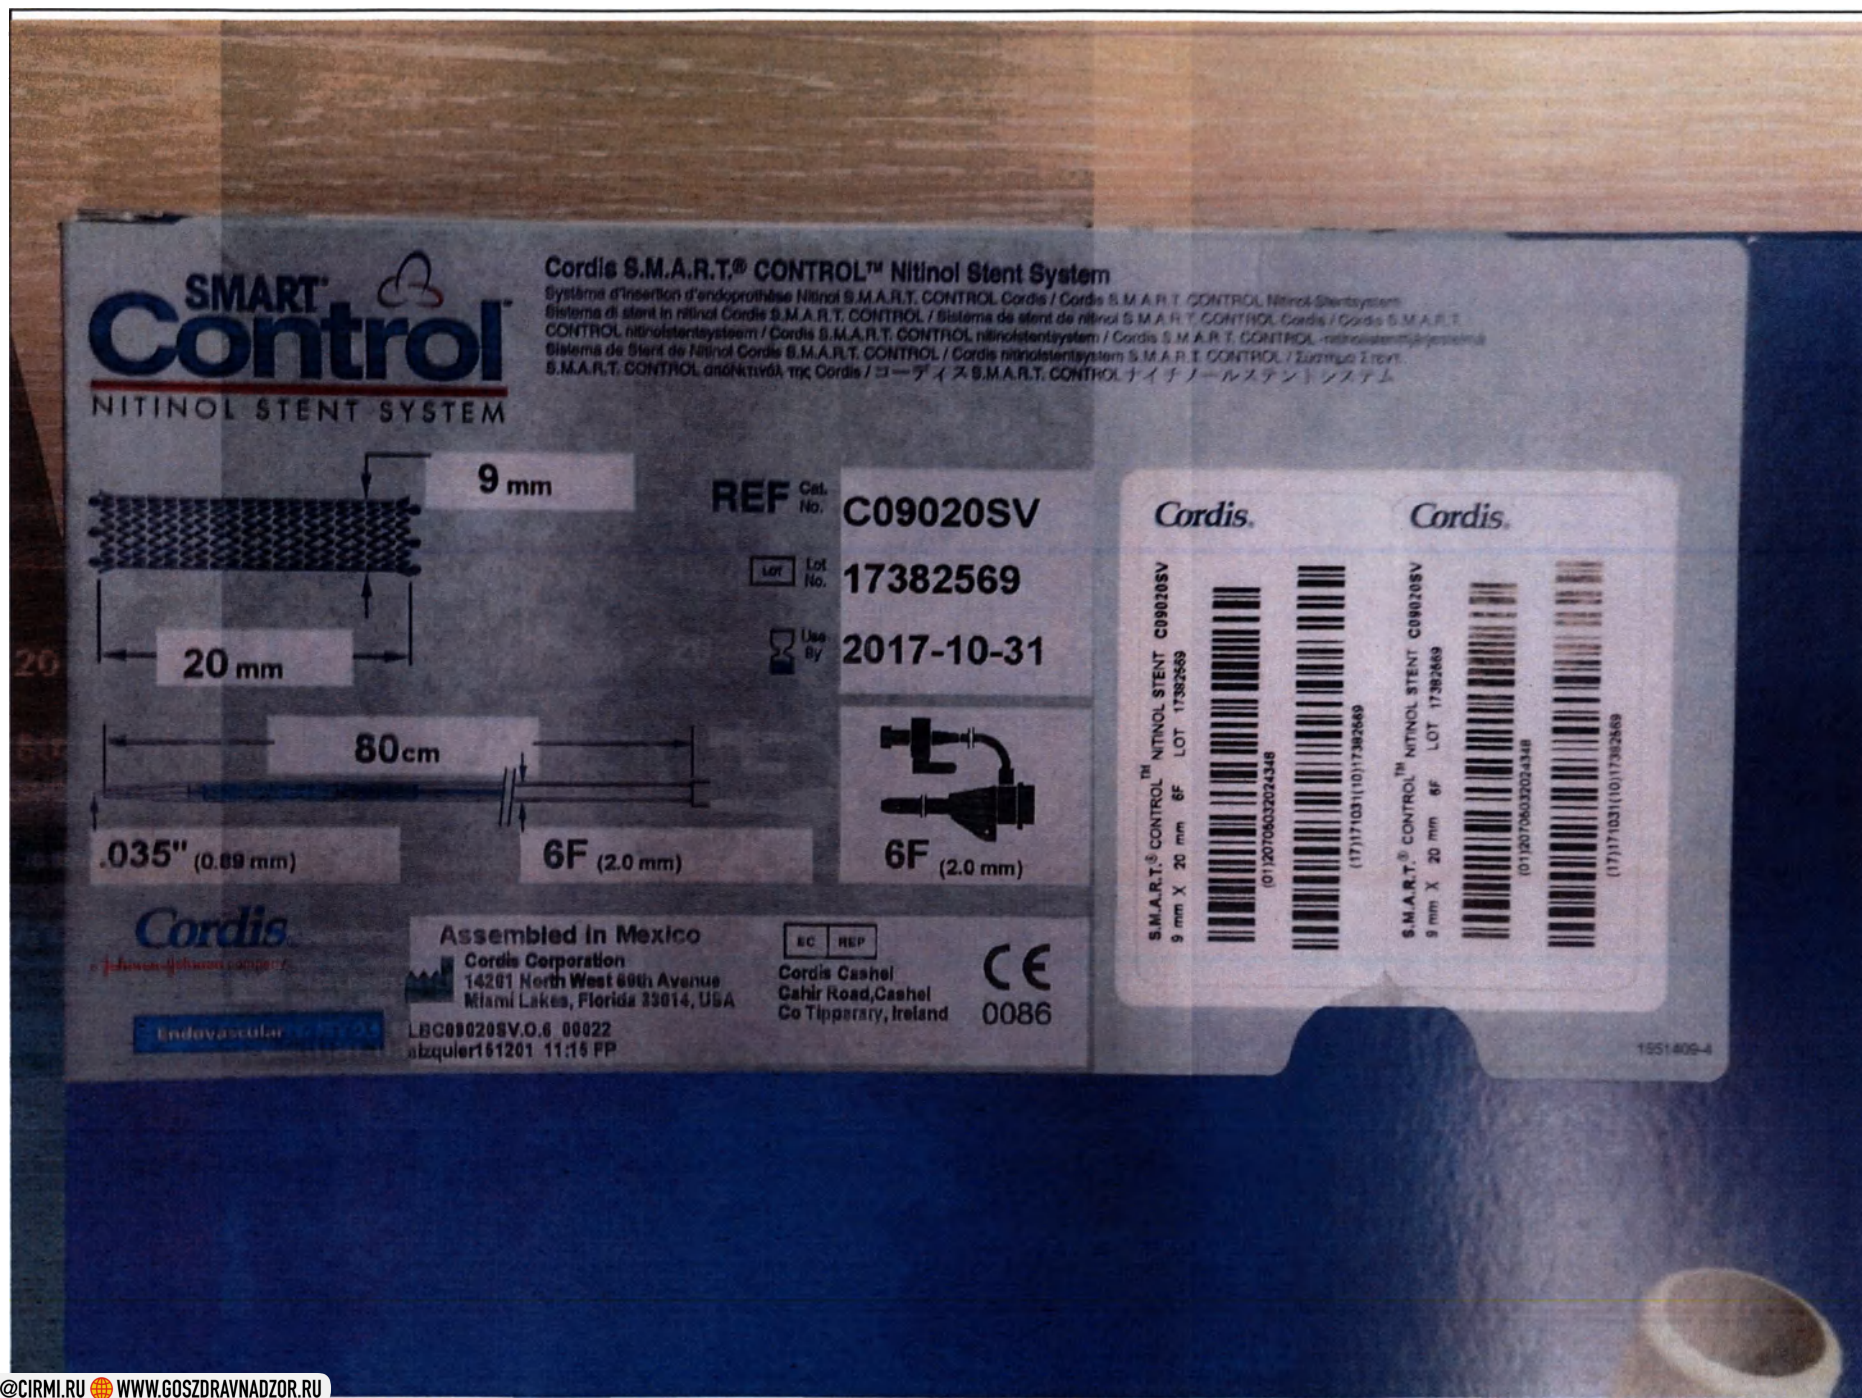

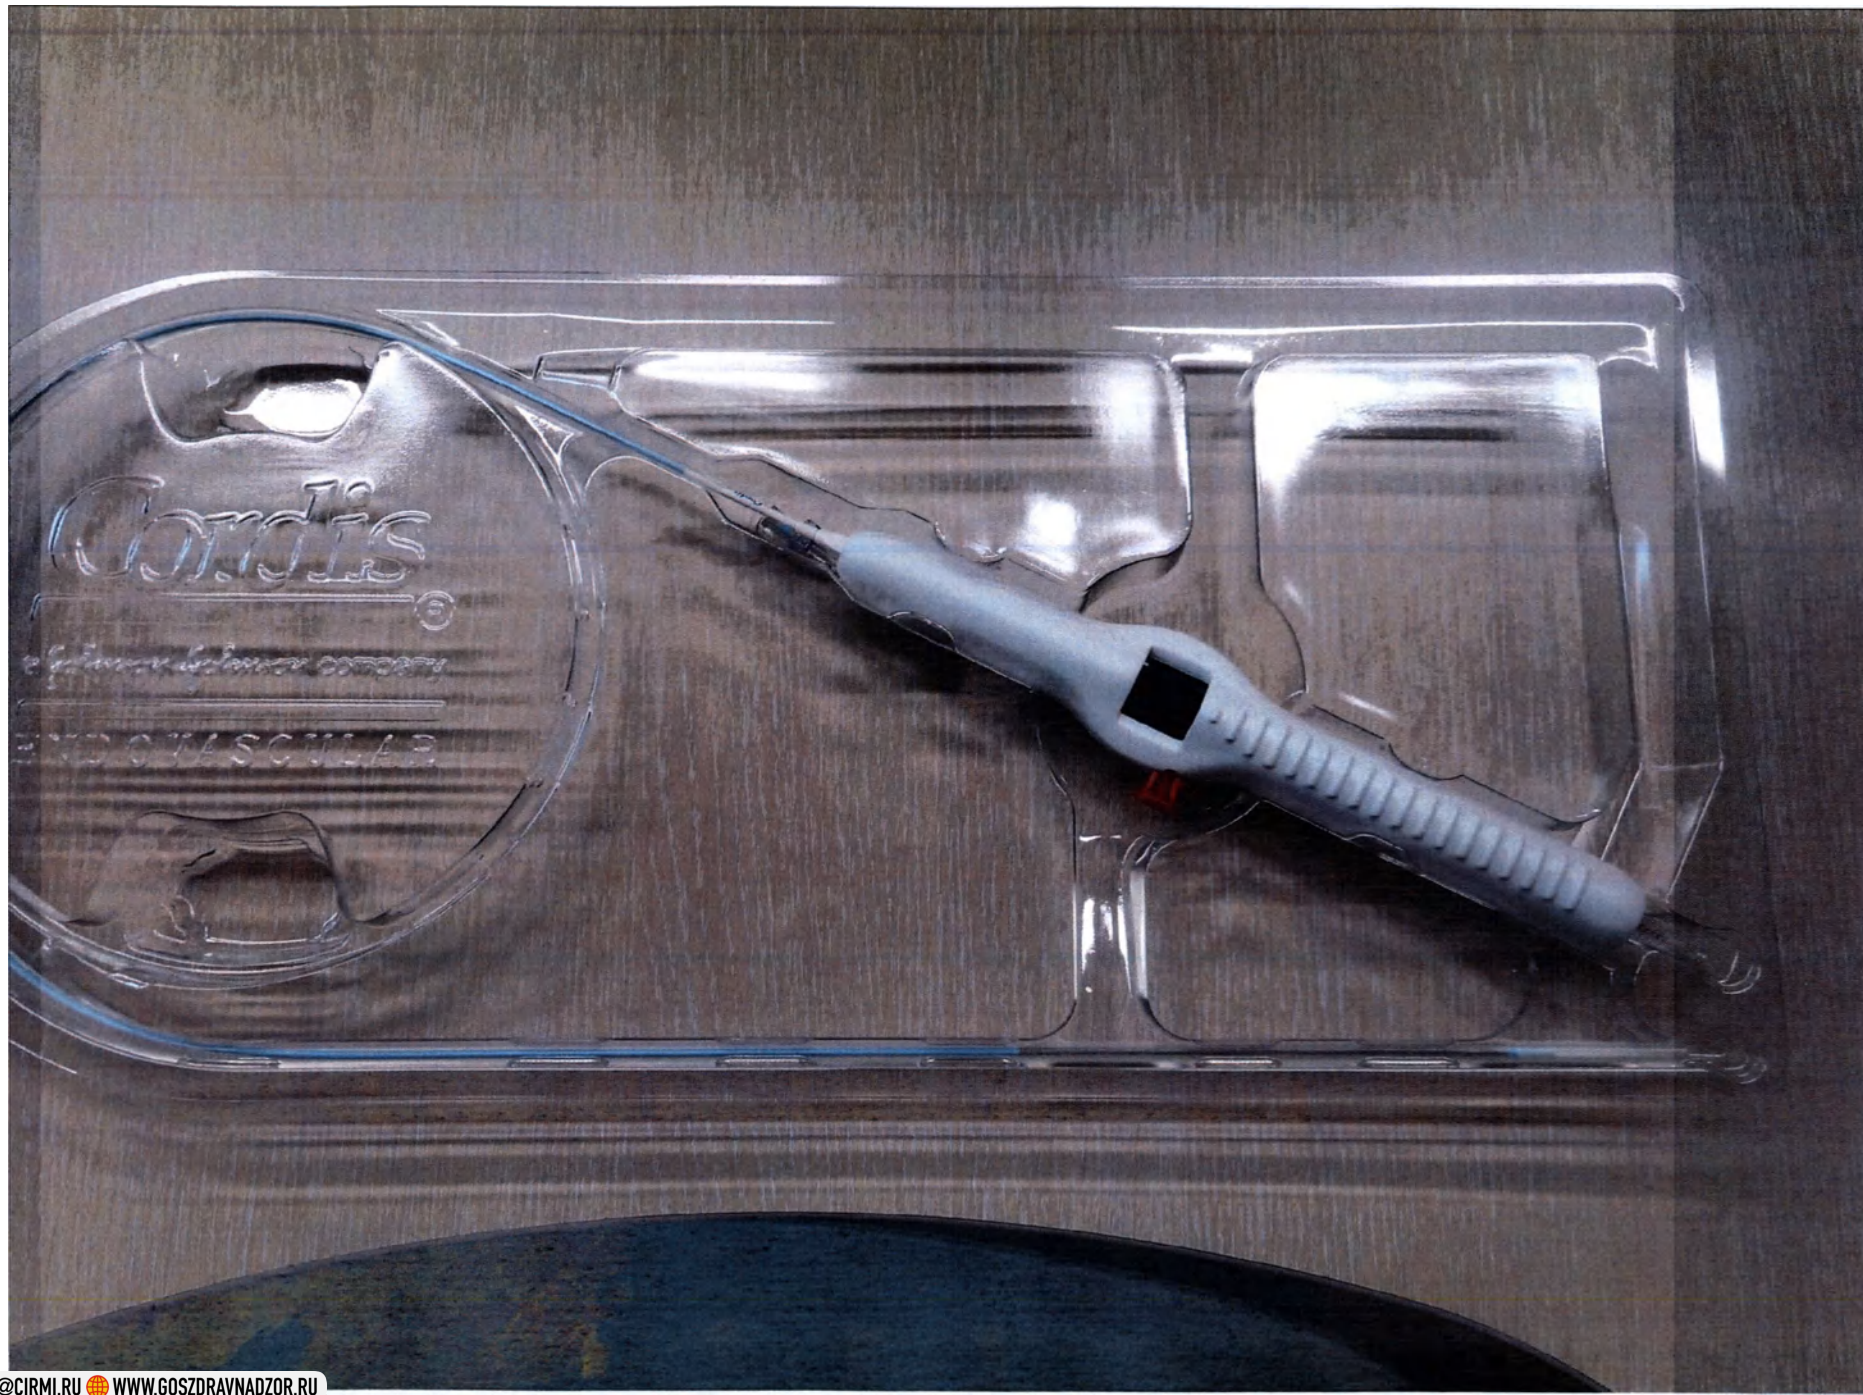

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: стент

Область применения: В медицине

Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
Мексике

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. – 7(495)5807777

Per. удост. РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул C09020SV 16211

PALMAZ
GenesisTM
PERIPHERAL STENT


PALMAZ GENESIS Peripheral Stent
Endoprothèse périphérique **GENESIS PALMAZ**
PALMAZ GENESIS Peripherer Stent
Stent periferico **PALMAZ-GENESIS**
Stent periférico **PALMAZ GENESIS**
PALMAZ GENESIS periferiestent
PALMAZ GENESIS perifer stent
PALMAZ GENESIS -perifeerinen stentti
Stent Periférico **PALMAZ GENESIS**
Periferstent **PALMAZ GENESIS**
Περιφερικό Στεντ **PALMAZ GENESIS**
PALMAZ GENESIS 抹消血管用ステント

XD


REF

Cat. No.

PG3910P



36 mm, 34 mm



10 mm, 12 mm

LOT

Lot
No.

N1014313

STERILE

STERILE

STERILE

Sterilized by Cobalt 60,
gamma radiation



Use
By

2018 - 09



For one use only.



Attention, see
Instructions for Use.

Nonpyrogenic. Radiopaque. Do not autoclave. Do not use open or
damaged packages. Store in a cool, dark, dry place.

XD

Extra Diameter / Très grand diamètre / Extra / Diametro Extra
Diámetro extra / Extra diameter / Ekstra diameter / Extra-läpimitta
Diámetro extra / Extrastor / Συμπληρωματική Διάμετρος / エクストラ

Cordis
a *Johnson & Johnson* company
ENDOVASCULAR



832-1

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных процедур: стент

Область применения: при лечении атеросклероза периферических артерий ниже дуги аорты

Условия хранения: Хранить в темном сухом, прохладном месте

Срок годности: 5 лет на упаковке

Производитель: Cordis Corporation, США, 14201 North West 60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA - Соединенные Штаты Америки


Импортер: ООО "Данисон & Данисон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. - 7(495)5907777

Рег. удост. РЗН 2015.3272 от 16.11.2015



Артикул PG3910P-16211

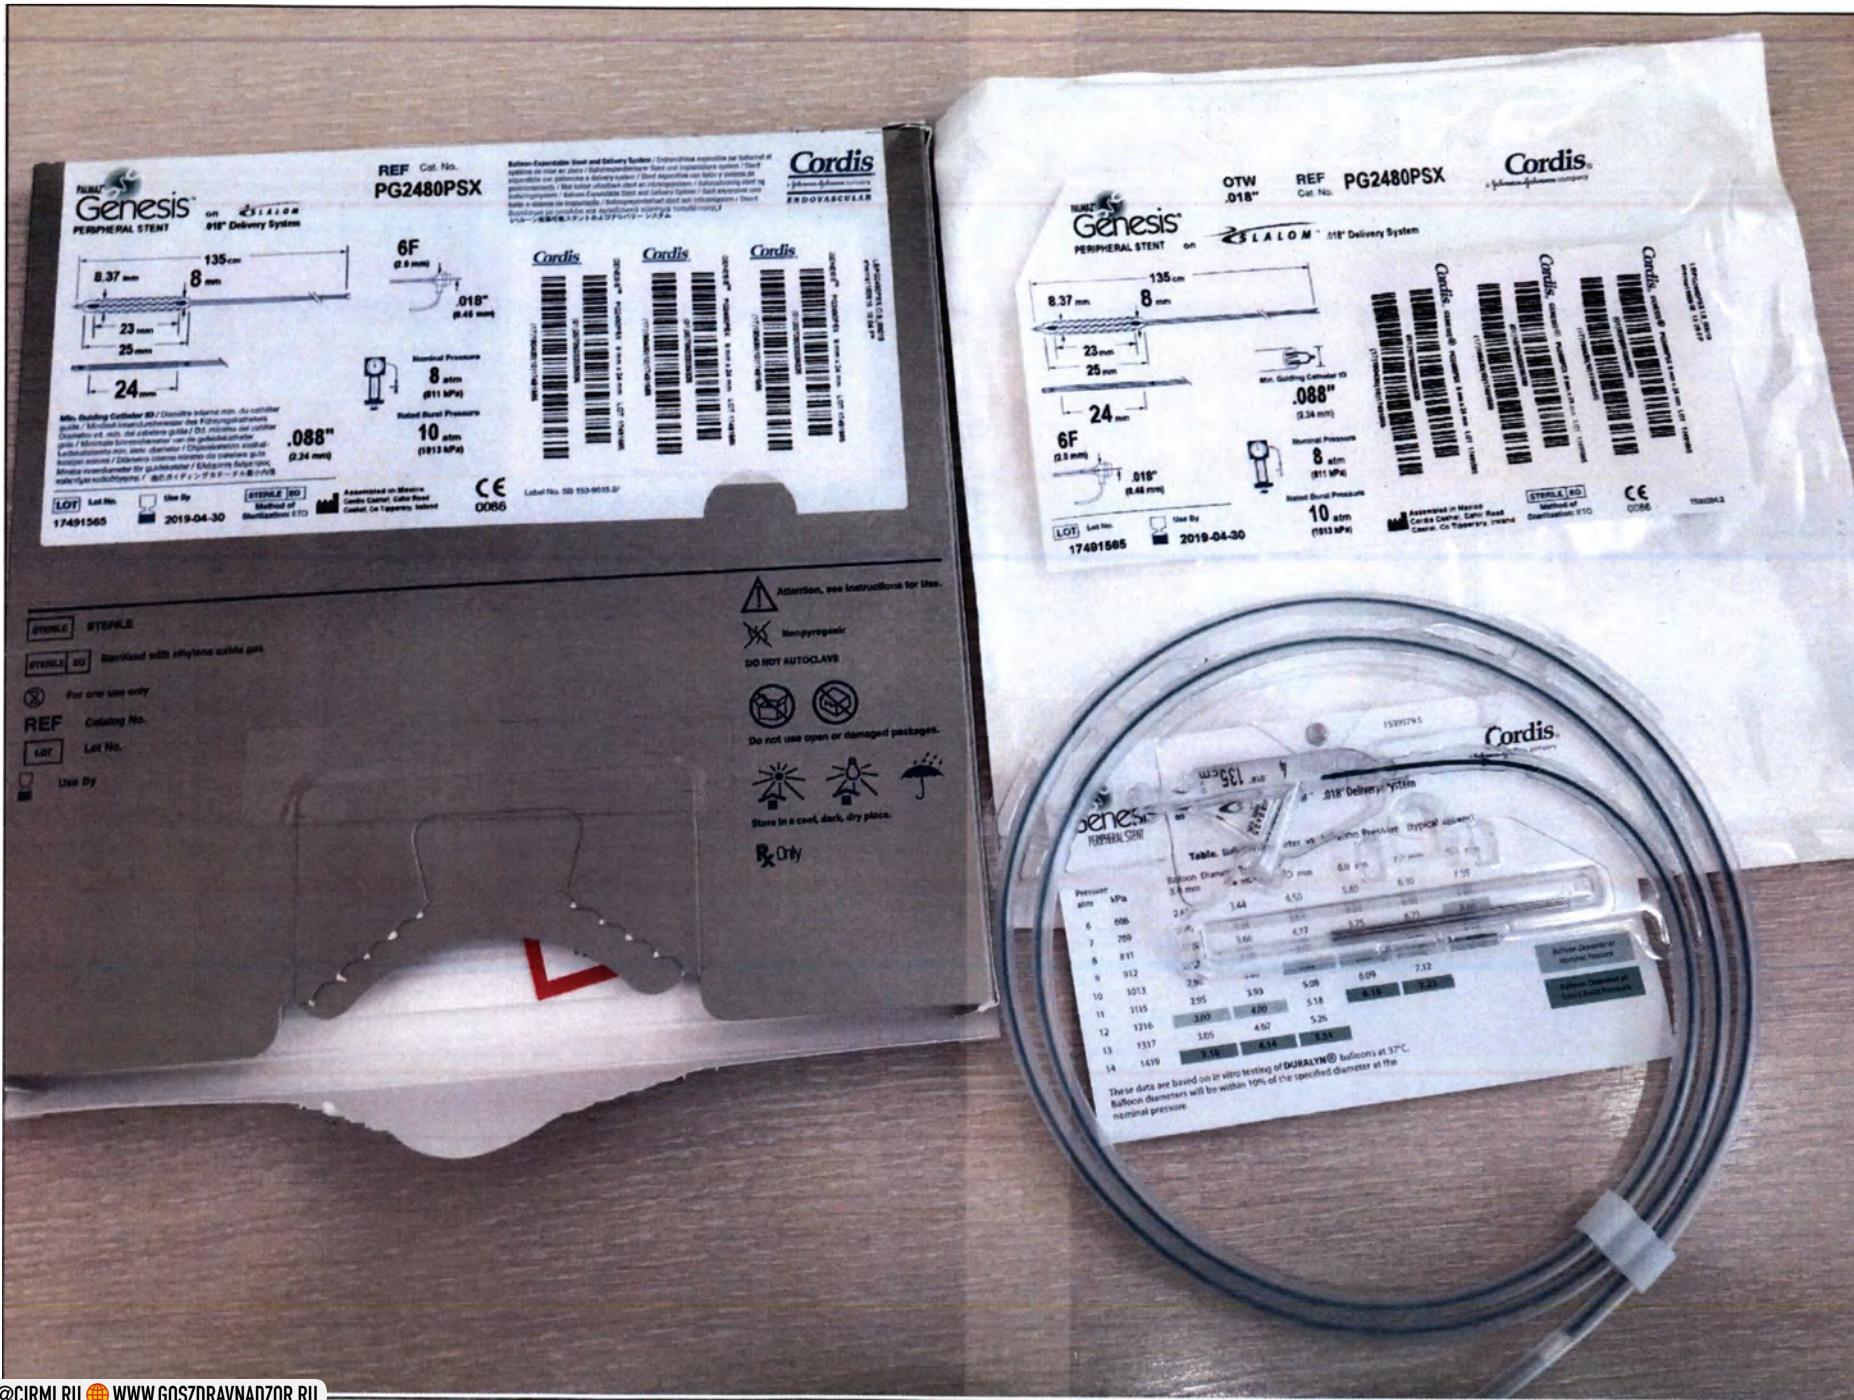

**Sample ONLY.
Not For Resale!**
**Бесплатный образец.
Не для продажи!**


Устройства для рентгеноваскулярных диагностических
и лечебных процедур: стент

Область применения: для лечения атеросклероза
периферических артерий и паллиативного лечения
злокачественных новообразований желчевыводящих путей
Условия хранения: Хранить в прохладном, темном, сухом месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: См. на упаковке
Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон" 121614, Москва, ул.
Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777
Рег. удост.: РЭН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул PG2480PSX 16340



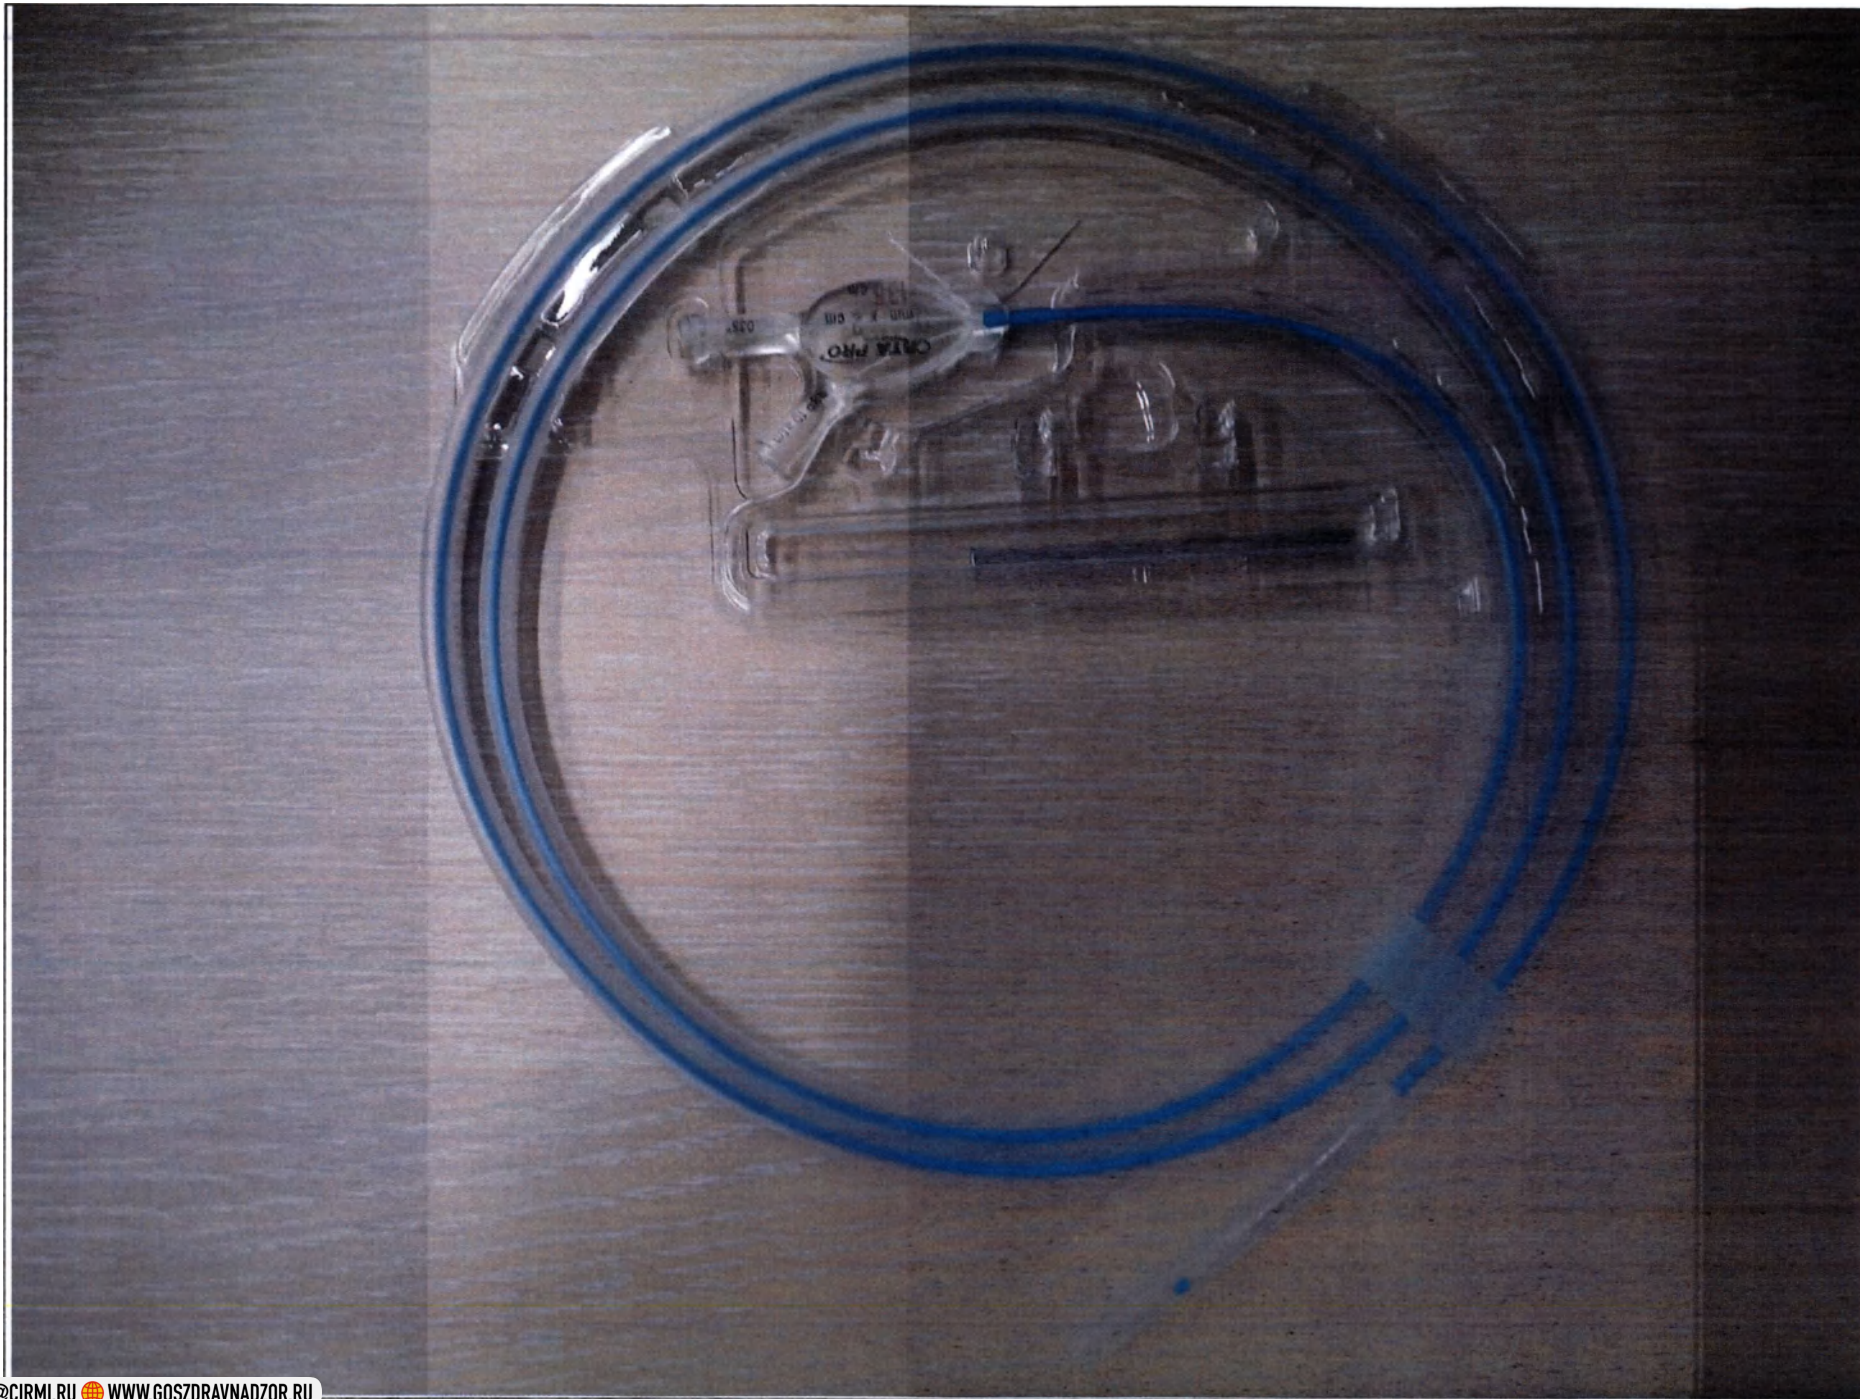


Устройства для рентгендоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: стент

Область применения: при лечении атеросклероза
периферических артерий и в качестве паллиативного средства
при новообразованиях в желчных протоках
Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте
Срок годности: См. на упаковке
Производитель: См. на упаковке
Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"
121614, Москва, ул. Крылатская д. 172, тел. - 7(495)5807777
Сер. удост.: РЗН 2015.3272 от 16.11.2015



Артикул PG1990PPX 16211

[illegible]

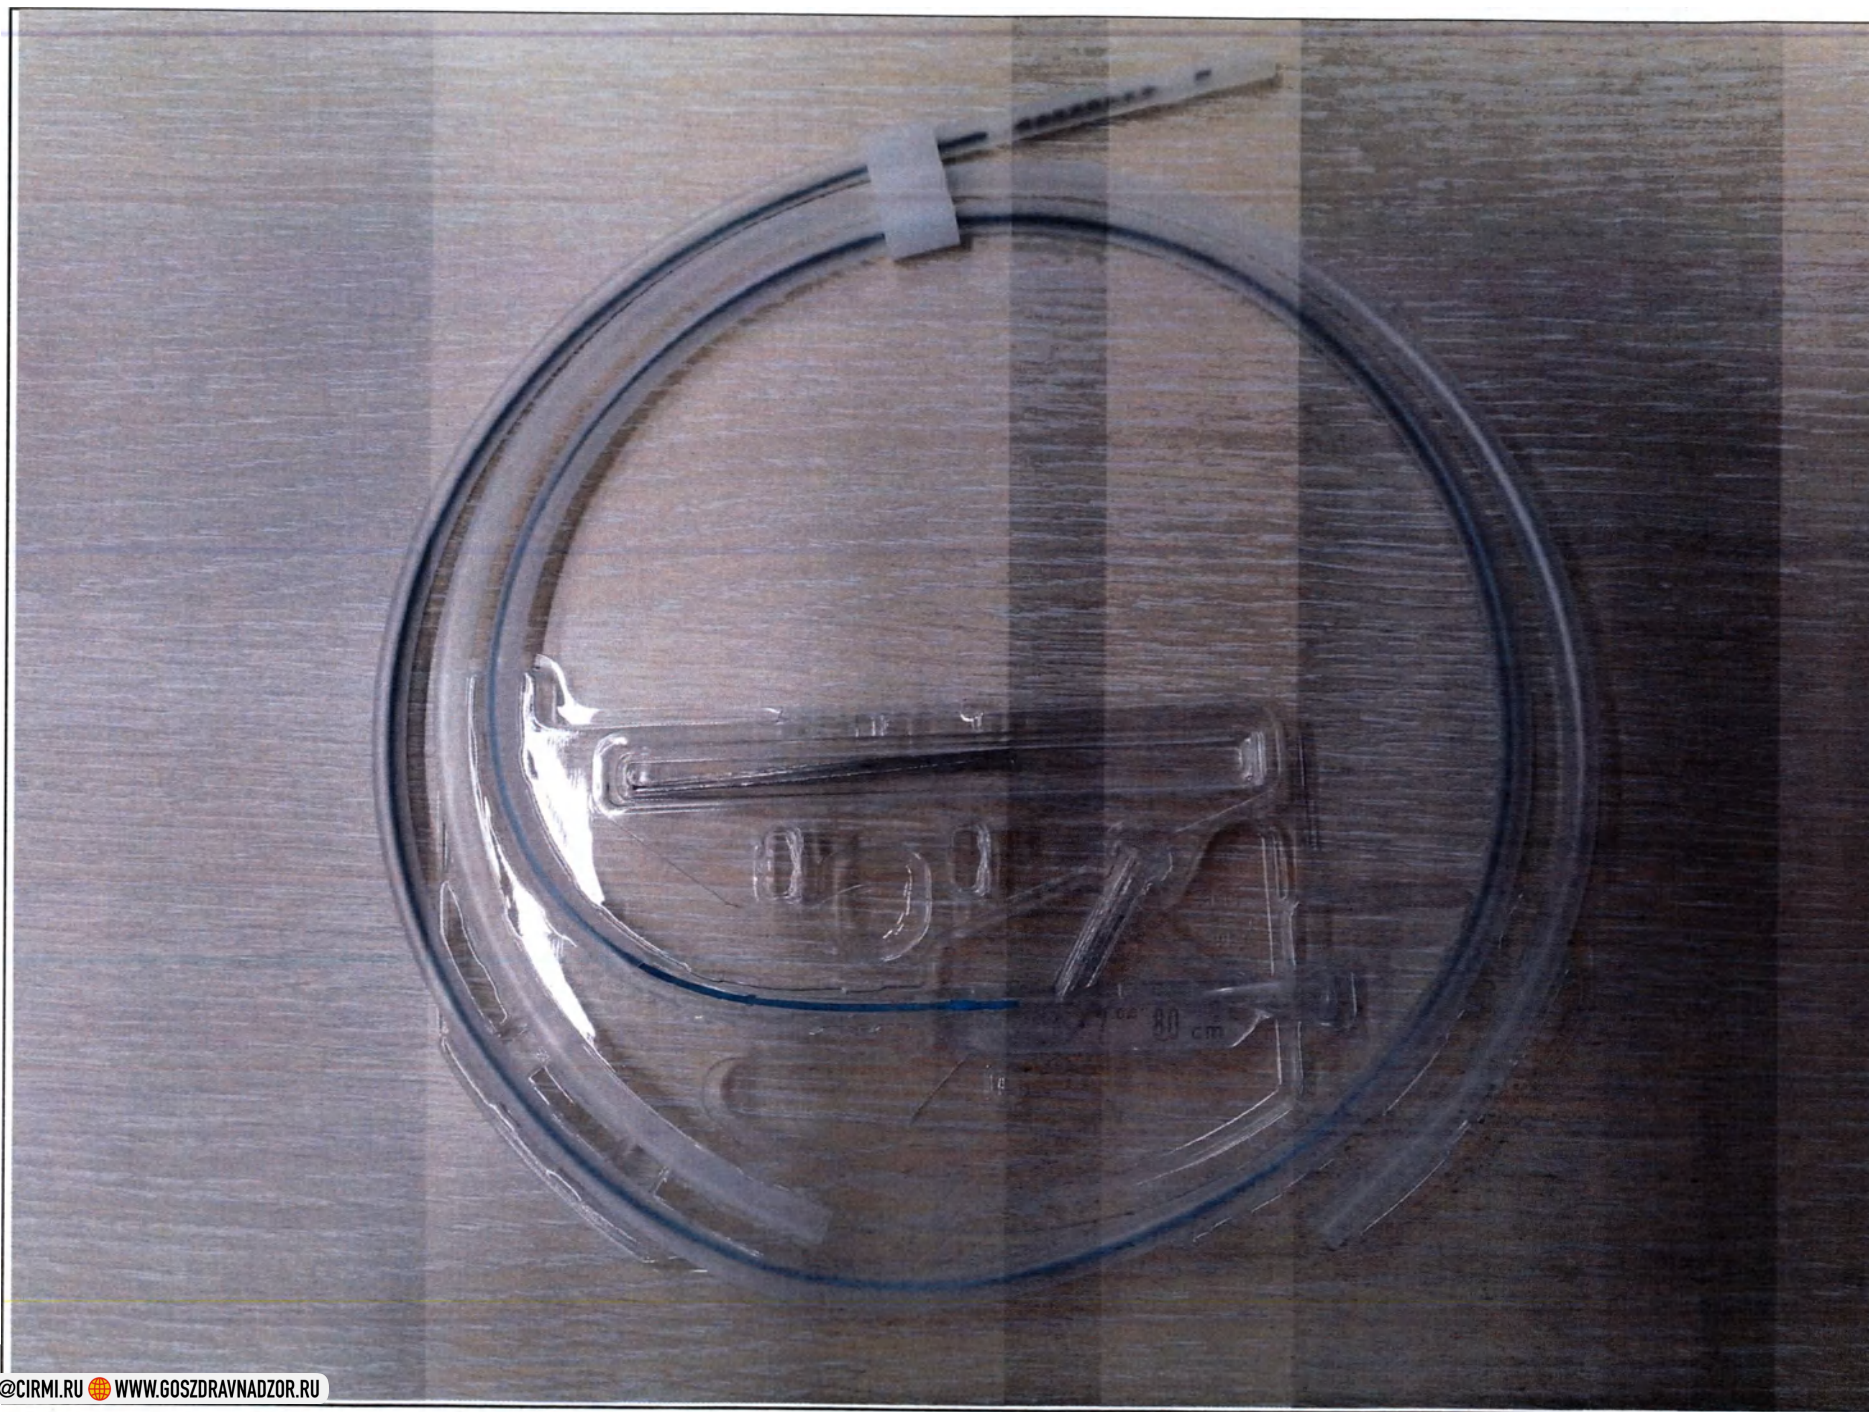

Стент

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°.

Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не использовать после истечения срока хранения.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Cordis Corporation, USA

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3272

Орган сертификации: -



Артикул PB2460PSS 15343

PALMAZ[®] Peripheral STENT

PALMAZ Peripheral Stent
Endoprothèse périphérique **PALMAZ**
PALMAZ Peripherer Stent
Stent periférico **PALMAZ**
Stent periférico **PALMAZ** / **PALMAZ** periferiestent
PALMAZ perifer stent / **PALMAZ** -periferinen stentti
Stent Periférico **PALMAZ** / Periferstent **PALMAZ**
Περιφερικό Στέντ **PALMAZ**
PALMAZ 抹消血管用ステント

REF
Cat. No.

P4014



37.79 - 30.58 mm



14 - 25 mm

LOT Lot No.

N0516304

STERILE

STERILE

STERILE

Sterilized by Cobalt 60,
gamma radiation

Contents: 1 stent

Nonpyrogenic. Radiopaque. Do not autoclave. Do not use open or
damaged packages. Store in a cool, dark, dry place.

Cordis
a Johnson & Johnson company
ENDOVASCULAR

Use By

2021-04-30



For one use only.



Attention, see
Instructions for Use.



9502-1

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: стент

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: Кордис Корпорейшн, США, 14201 North West
60th Avenue, Miami Lakes, Florida FL 33014, USA. Собрано в
США

Импортёр: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015

LBP4014.O.3_00004
anorris5160503 06:47 FP

Артикул P4014 16211



14. USA



Фильтр

Область применения: Хирургия

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°.

Избегать контакта с влагой и направленным жаром. Не использовать после истечения срока хранения.

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: См. на упаковке

Импортёр: ООО "Джонсон&Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: 2015/3272 от 16.11.2015

Орган сертификации: -



Артикул 466P306A 16095





Cashel, Co Tipperary, Ireland

Фильтры opEase

Устройства для рентгенэндоваскулярных диагностических
и лечебных процедур: фильтр

Область применения: показан для профилактики легочной
эмболии и вводится чресножно в нижнюю полую вену пациентам

Условия хранения: Хранить в темном, сухом, прохладном месте

Срок годности: См. на упаковке

Производитель: См. на упаковке

Импортер: ООО "Джонсон & Джонсон"

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17/2, тел. + 7(495)5807777

Рег. удост.: РЗН 2015/3272 от 16.11.2015



Артикул 466F210B 16211

ПРОШИТО
Листов 149

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
149 Листов
КИМ О.Л.

