




ООО «СЕМ ТЕСТ ИНСТРУМЕНТ»

ИНН/КПП 5024176637/502401001 Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 69-й км МКАД,
МТБК «Гринвуд» строение 1, офис 32. Тел.: (495) 213-31-68

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА медицинского изделия

Набор реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазка из носа человека методом
иммунохроматографического анализа COVID-19 Antigen Rapid Test, LOT SJJT012204001

2022

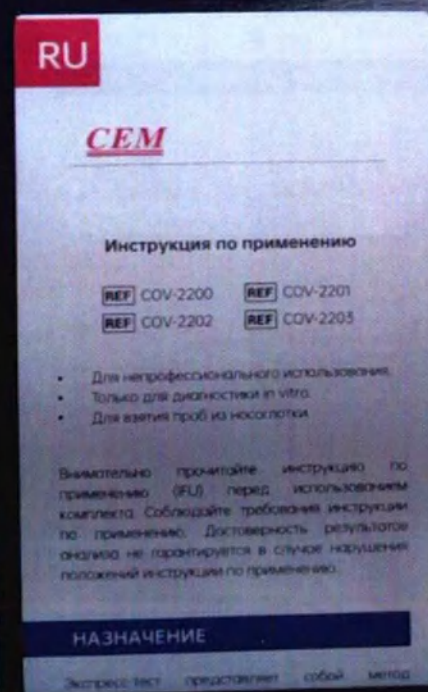

CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test



LOT SJJT012204001  2023-10-13

REF COV-2201  2022-4-14

Use within 1 hour after opening the foil pouch.

1 Test

CE 2934

CEM

COVID-19 Test

C T

15mins

Sx3

Буфер для экстрегирования во флаконе 0.5 мл

Σ 2023 10 13



LOT SJJT012204001

ПРОБКА 0.5 мл



RU

CEM

Инструкция по применению

REF COV-2200

REF COV-2201

REF COV-2202




REF COV-2203

- Только для диагностики in vitro.
- Для взятия проб из носоглотки.

Внимательно прочитайте инструкцию по применению (IFU) перед использованием комплекта. Соблюдайте требования инструкции по применению. Достоверность результатов анализа не гарантируется в случае нарушения положений инструкции по применению.


НАЗНАЧЕНИЕ

Экспресс-тест представляет собой метод

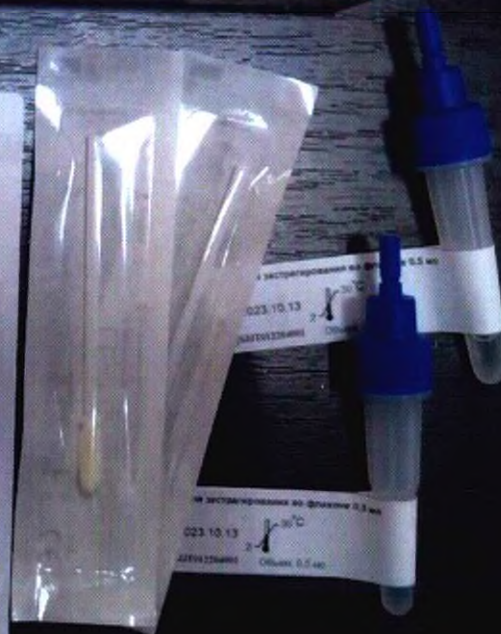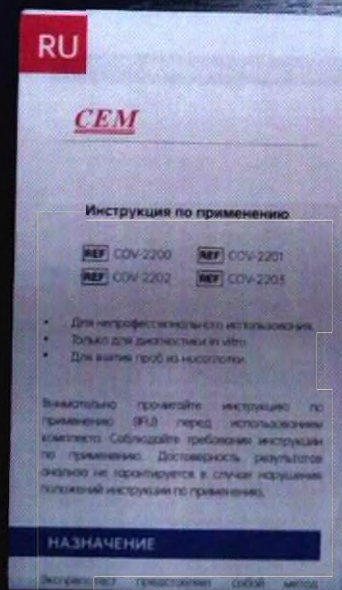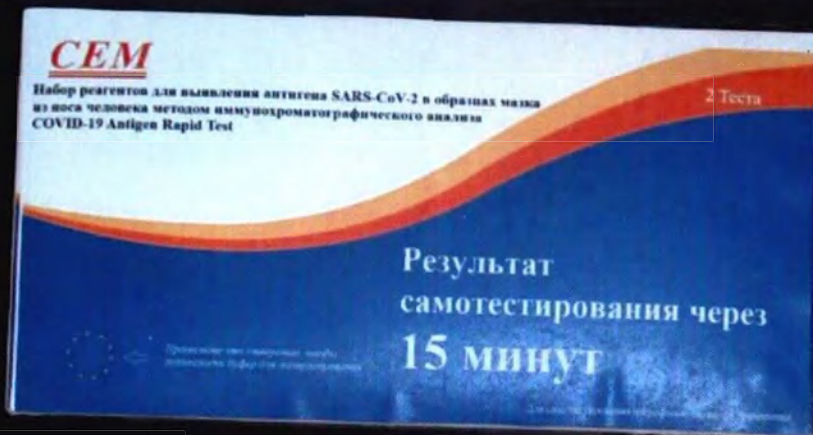

CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test



LOT SJJT012204001 2023-10-13

REF COV-2201 2022-4-14

Use within 1 hour after opening the foil pouch.

1 Test

CE 2934

CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test



LOT SJJT012204001 2023-10-13

REF COV-2201 2022-4-14

Use within 1 hour after opening the foil pouch.


1 Test

CE 2934

CEM


COVID-19Test


C T



15mins

S×3

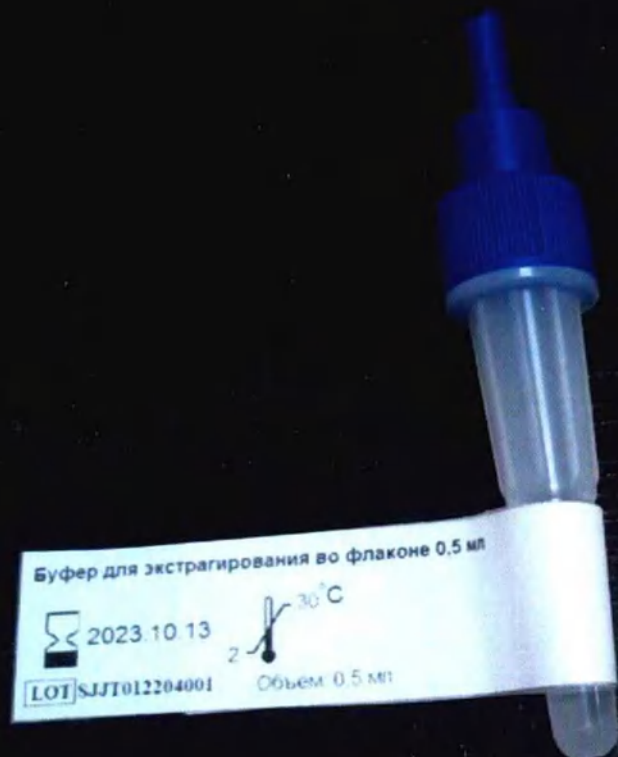

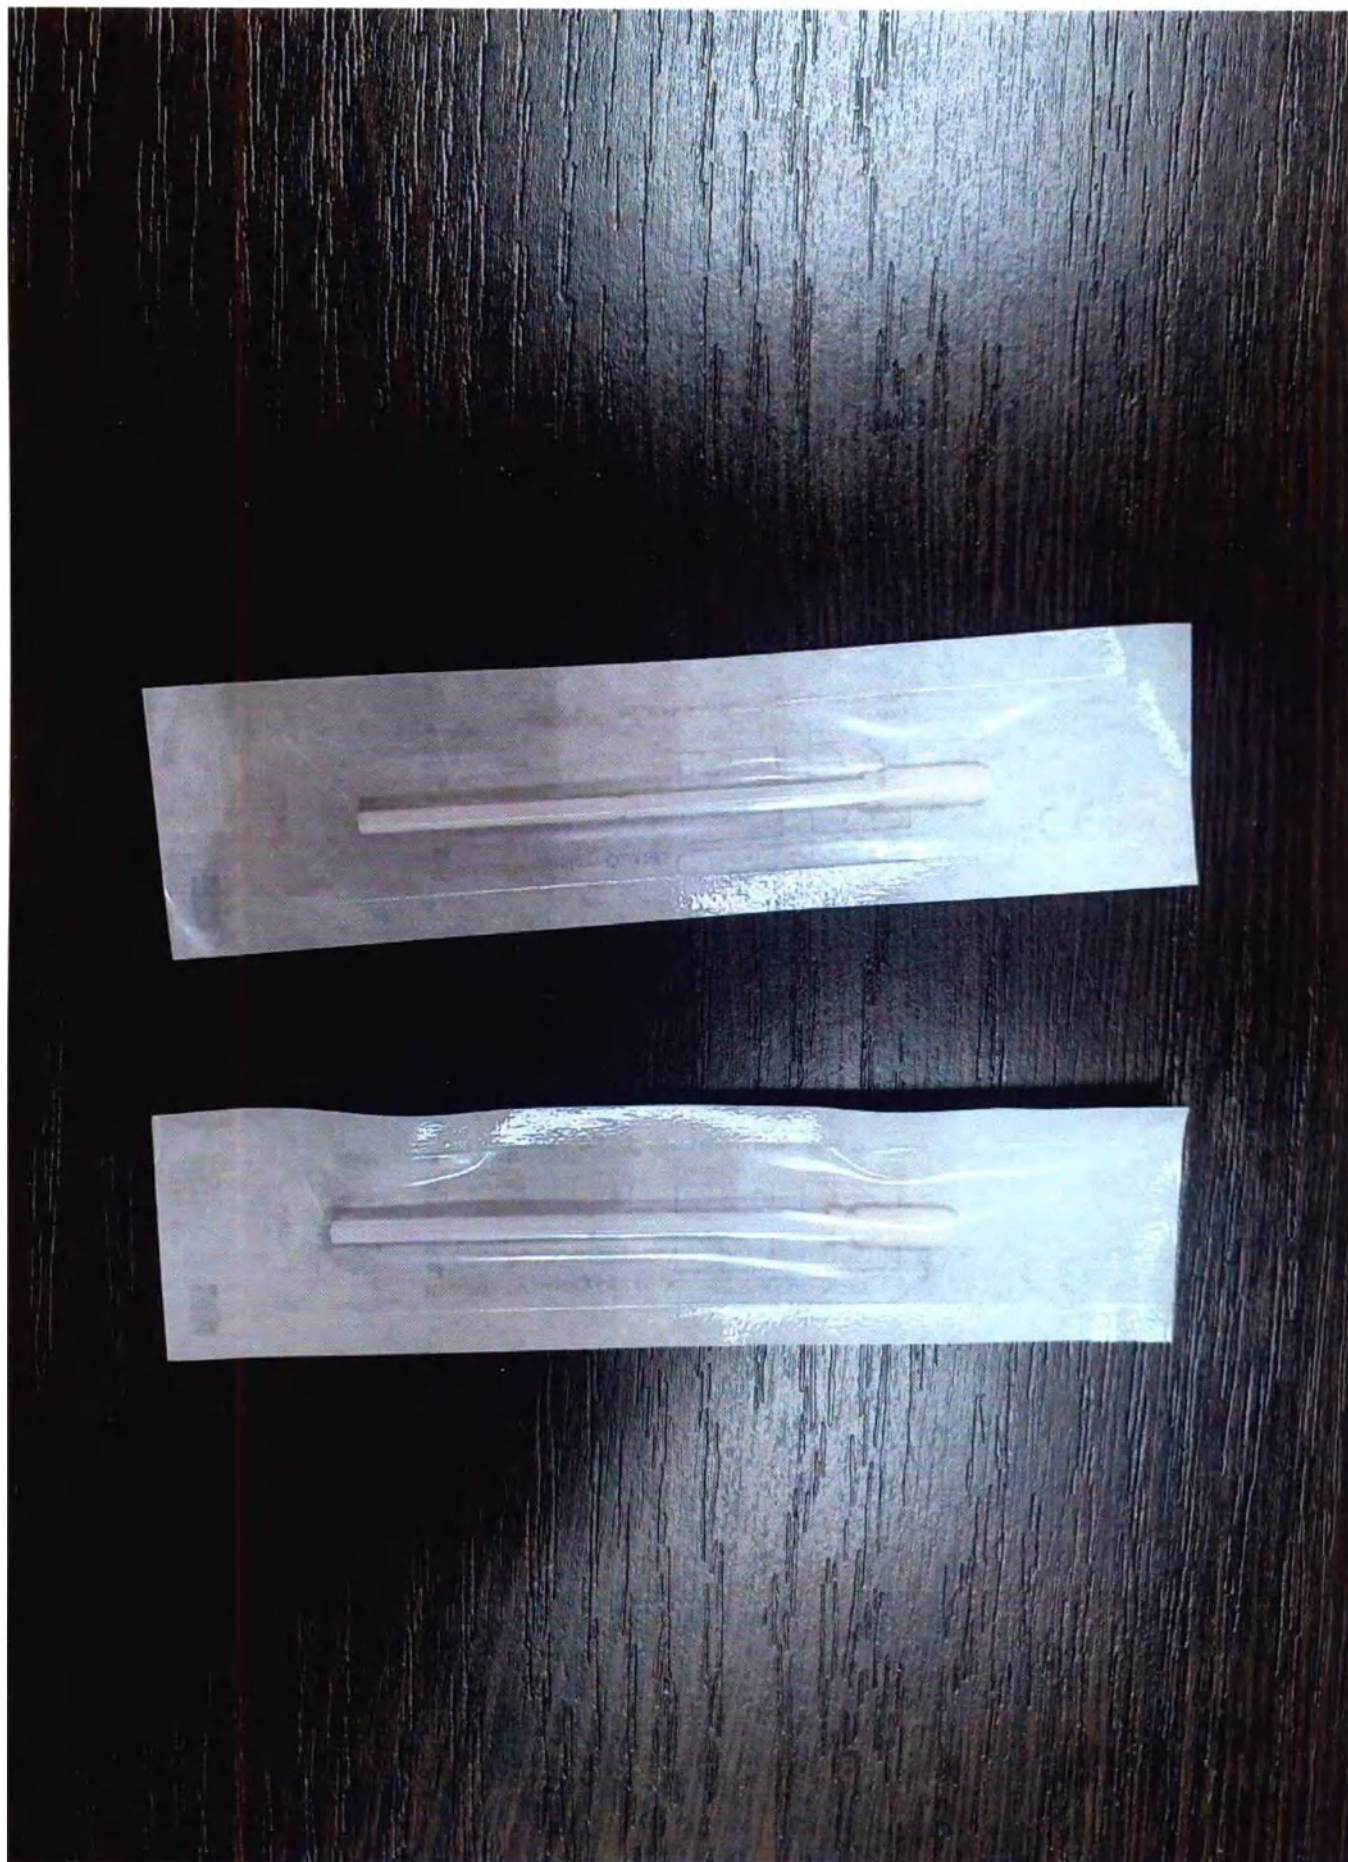

RU

CEM

Инструкция по применению

REF COV-2200

REF COV-2201

REF COV-2202

REF COV-2203

- Только для диагностики in vitro.
- Для взятия проб из носоглотки.

Внимательно прочитайте инструкцию по применению (IFU) перед использованием комплекта. Соблюдайте требования инструкции по применению. Достоверность результатов анализа не гарантируется в случае нарушения положений инструкции по применению.

НАЗНАЧЕНИЕ

Экспресс-тест представляет собой метод иммунохроматографического анализа с боковым

CEM

Набор реактивов для выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазка из носа человека методом иммунохроматографического анализа
COVID-19 Antigen Rapid Test

5 Тестов

**Результат
самотестирования через
15 минут**

CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test

LOT: SJ1012204001
 REF: CUV-2202
 2023-10-13

1 Тест

CE 2034

CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test

LOT: SJ1012204001
 REF: CUV-2202
 2023-10-13

1 Тест

CE 2034

RU

CEM

Инструкция по применению

REF: CUV-2200 REF: CUV-2201
 REF: CUV-2202 REF: CUV-2203

• Для иммунохроматографического анализа
 • Только для диагностики in vitro
 • Для домашнего использования

Важно! При использовании набора реактивов необходимо соблюдать следующие правила:
 • Не касаться кончика палочки для забора мазка
 • Не использовать набор реактивов после истечения срока годности

НАЗНАЧЕНИЕ

Исследование мазка из носа человека на наличие антигена SARS-CoV-2


Картонные упаковки тестовых палочек с инструкциями и логотипом CEM.

Стеклянные пипетки с белыми колпачками и этикетками:

- Этикетка 1: "Картон для исследования в объеме 0,5 мл", "2023.10.13", "2023.10.13", "0,5 мл", "0,5 мл"
- Этикетка 2: "Картон для исследования в объеме 0,5 мл", "2023.10.13", "2023.10.13", "0,5 мл", "0,5 мл"
- Этикетка 3: "Картон для исследования в объеме 0,5 мл", "2023.10.13", "2023.10.13", "0,5 мл", "0,5 мл"
- Этикетка 4: "Картон для исследования в объеме 0,5 мл", "2023.10.13", "2023.10.13", "0,5 мл", "0,5 мл"

CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test



LOT SJJT012204001 **EXP** 2023-10-13

CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test



LOT SJJT012204001

CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test



LOT SJJT012204001 **EXP** 2023-10-13

REF COV-2202 **EXP** 2022-4-14


CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test



CEM

COVID-19 Antigen Rapid Test



LOT SJJT012204001 **EXP** 2023-10-13

REF COV-2202 **EXP** 2022-4-14

Use within 1 hour after opening the foil pouch.

1 Test

CE 2934

COVID-19 Test

CEM

C T

15mins

Sx3





RU

CEM

Инструкция по применению

REF COV-2200

REF COV-2201

REF COV-2202

REF COV-2203

- Только для диагностики in vitro.
- Для взятия проб из носоглотки.

Внимательно прочитайте инструкцию по применению (IFU) перед использованием комплекта. Соблюдайте требования инструкции по применению. Достоверность результатов анализа не гарантируется в случае нарушения положений инструкции по применению.

НАЗНАЧЕНИЕ

Экспресс-тест представляет собой метод иммунохроматографического анализа с боковым

CEM


Набор реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах
мочи и носа человека методом иммунохроматографического
анализа COVID-19 Antigen Rapid Test, LOT SJJT012204001


25 Тестов

Результат
самотестирования через
15 минут






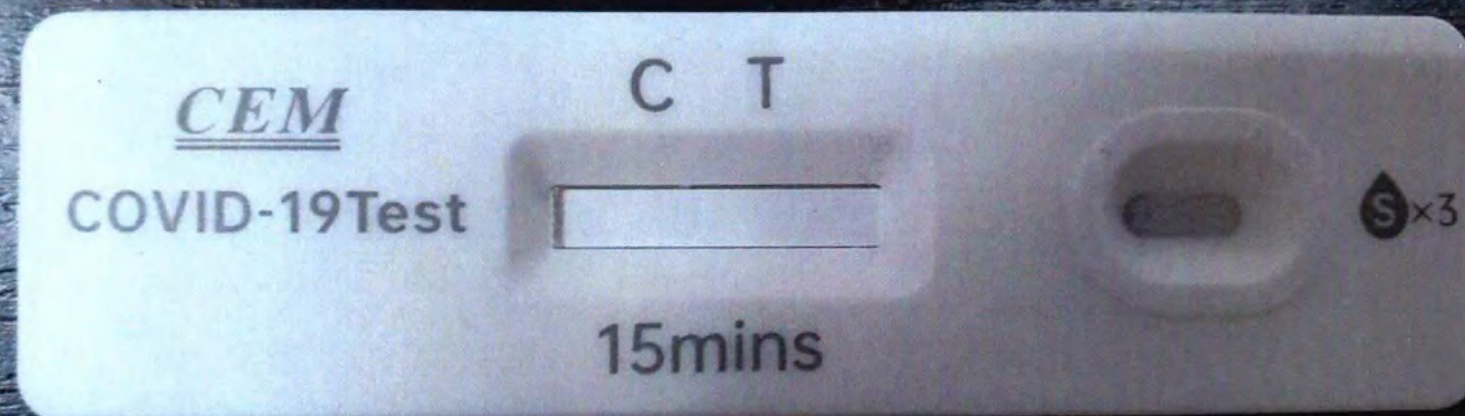

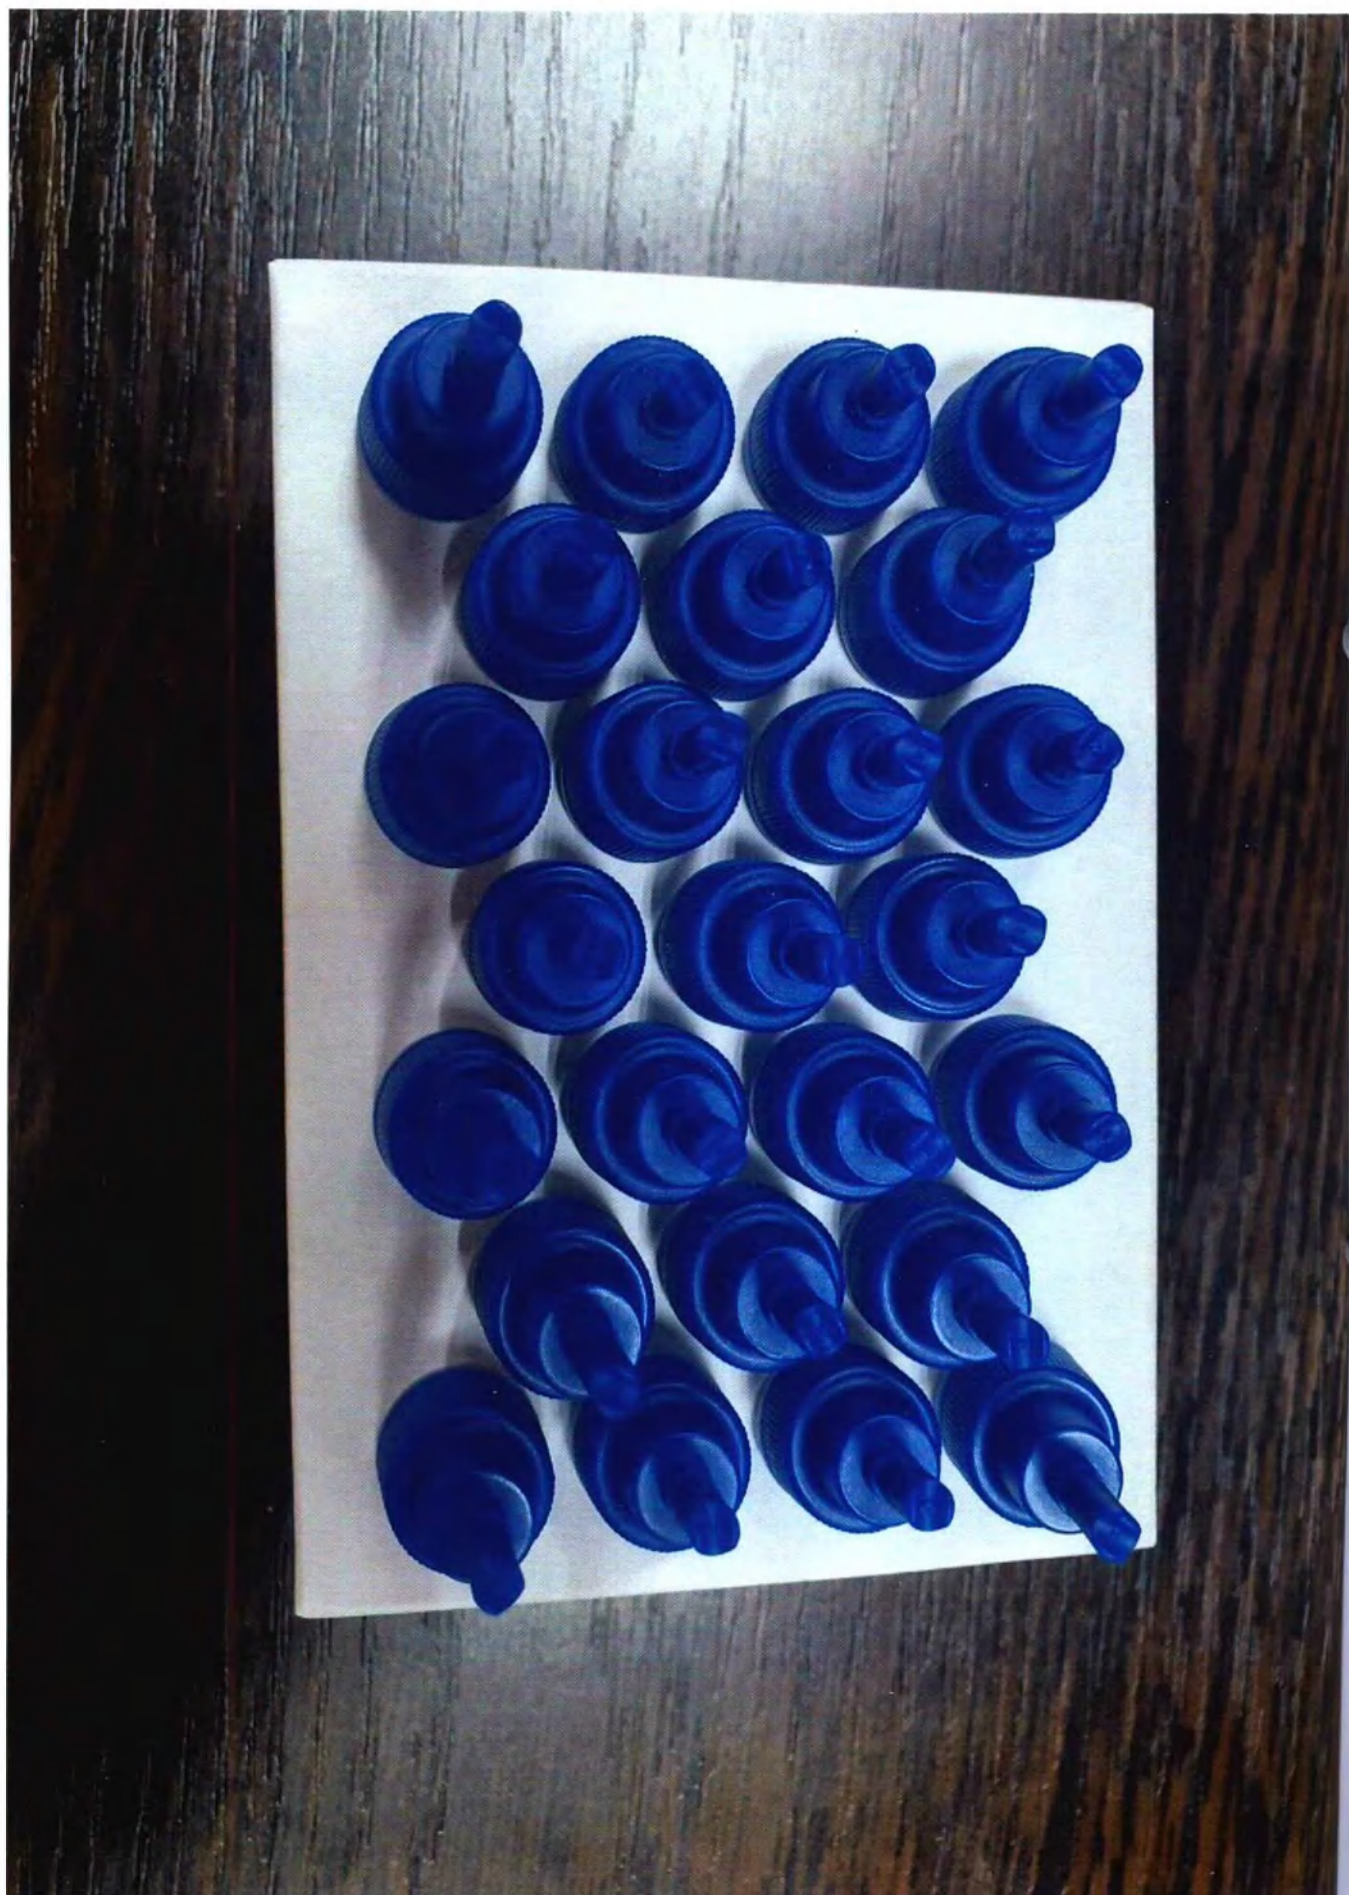



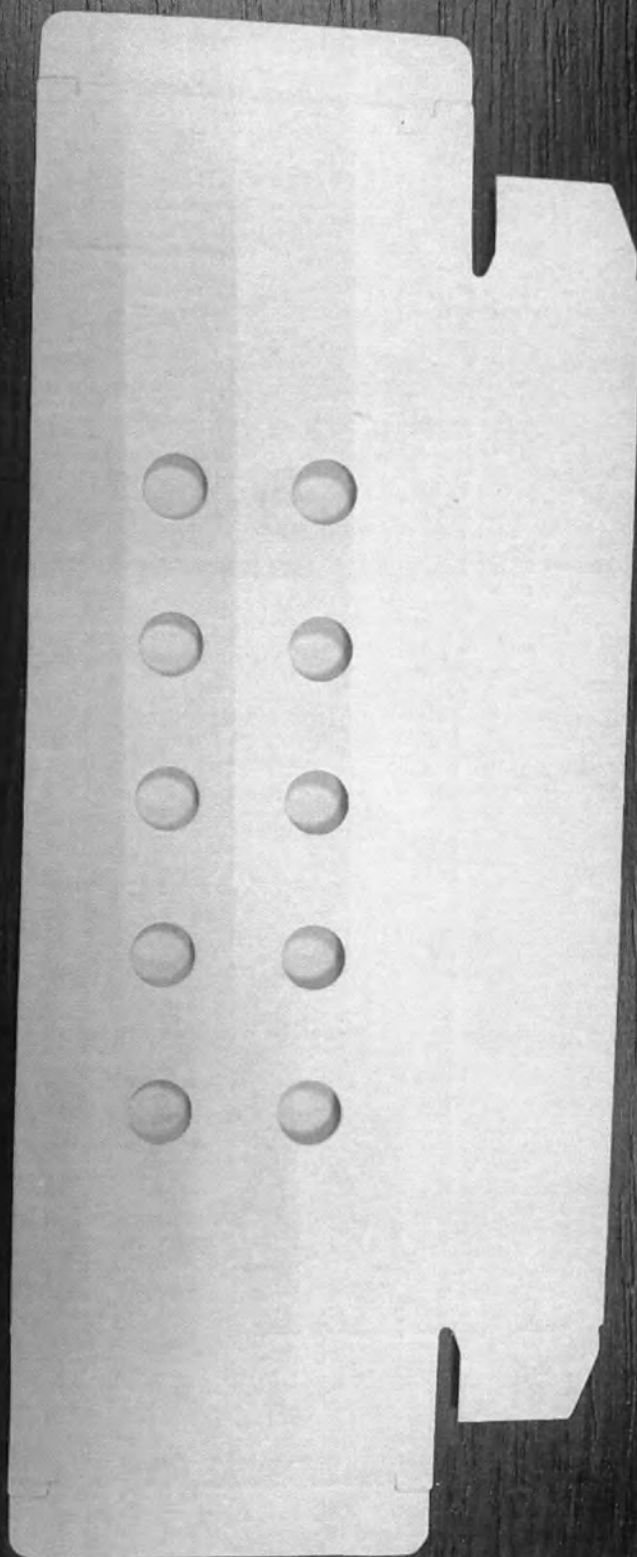

RU

CEM

Инструкция по применению

REF COV-2200

REF COV-2201

REF COV-2202

REF COV-2203

- Только для диагностики in vitro.
- Для взятия проб из носоглотки.

Внимательно прочитайте инструкцию по применению (IFU) перед использованием комплекта. Соблюдайте требования инструкции по применению. Достоверность результатов анализа не гарантируется в случае нарушения положений инструкции по применению.

НАЗНАЧЕНИЕ

Экспресс-тест представляет собой метод иммунохроматографического анализа с боковым

ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ

CEM

COVID-19

Набор реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах
мазка из носа человека методом иммунохроматографического
анализа COVID-19 Antigen Rapid Test, LOT SJJT012204001

25 Тестов

Результат
самотестирования через
15 минут



Для самотестирования и профессионального применения



Осторожно введите зонд для забора биоматериала на глубину 1,2-1,9 см в одну ноздрю.
Медленно вращайте зонд, прикладывая умеренное усилие, не менее пяти раз по внутренней стороне ноздри в течении 15 секунд.
Кончик зонда должен касаться внутренней стенки ноздри при каждом повороте зонда.
Используя тот же самый зонд, повторите сбор образца из другой ноздри.



Снимите крышку с капельницы и капните в лунку тестовой кассеты три капли жидкости из пробирки.




Установите таймер на 15 минут




Вставьте зонд в пробирку с буфером для экстракции, коснитесь его кончиком дна пробирки и вращайте его не менее 15 раз.
Сожмите края пробирки чтобы произошел полный перенос материала с зонда в буферный раствор.
Выбросьте зонд, плотно закройте насадку-капельницу на пробирке. Хорошо перемешайте жидкость.

Считайте результат



Положительный результат



Отрицательный результат



Недействительный результат

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «СЕМ ТЕСТ ИНСТРУМЕНТ»
ИНН: 5024176637
143441, Московская область, Красногорский район, Почтовое отделение Путилково, улица 69 км МКАД, Комплекс ЗАО «ГРИНВУД», строение 1, помещение 32
Тел.: 8 (916) 8502678, 8 (916) 7817010

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Набор реагентов использовать только в одноразовых перчатках (не входят в состав набора реагентов)

Rev.220325



Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd.
No 101-501, 19th Building & 21st Building, Baiwangxin Industrial Park, No. 1002, Songbai Road, Yangguang Community, Xili Street, Nanhai District 518108, Shenzhen City, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-27353188
www.cem-instruments.com



Kingsmead Service B.V.
Zonnehof 36, 2632 BE, Noodorp, Netherland
E-mail: office@kingsmead-service.com
Tel: +31(0)646571005



REF COV-2202

CODE



Набор реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазка из носа человека методом иммунохроматографического анализа COVID-19
Antigen Rapid Test, LOT SJJT012204001



Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше

Следуйте инструкциям на видео, чтобы быстро начать тест

<https://www.cem-instruments.com/en/Product/COVID-19AntigenRapidTest/covid-19.html>

LOT SJJT012204001

2022-4-14

2023-10-13

Состав



5 x Тестовые кассеты




5 x Зонд для забора биоматериала



5 x Буфер для инкубирования



1 x Инструкция по применению



Буфер для экстрагирования во флаконе 0,5 мл



2023.10.13



LOT SJJT012204001

Объем: 0,5 мл

ВСЕГО ПРОШЛО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 21 ЛИСТ(ОВ)

