

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet FT4 IV cobas e analyzers),

производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

для калибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet FT4 IV cobas e analyzers)



калибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet FT4 IV cobas e analyzers)

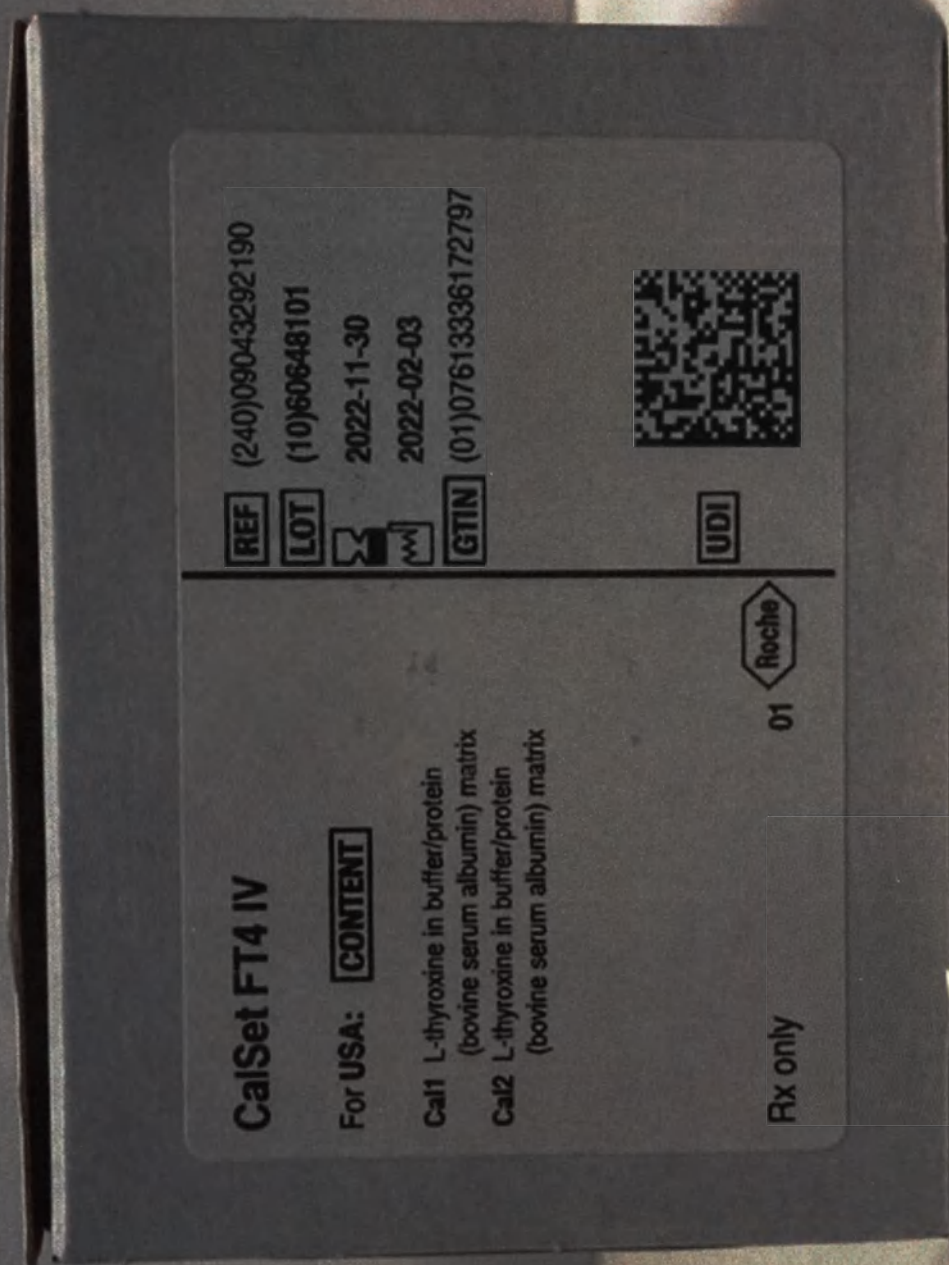

калибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet FT4 IV cobas e analyzers)

Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet FT4 IV cobas analyzers):

1. Калибратор 1, FT4 4 Cal1: флакон, объем 1,0 мл, 2 шт.
2. Калибратор 2, FT4 4 Cal2: флакон, объем 1,0 мл, 2 шт.
3. Карта со штрих-кодом
4. Этикетки для флаконов, 12 шт.
5. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № PZN 2019/0061 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik GmbH"), Sandhof Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Их использование только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель: производятся на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Р

Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трудовая площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99,

факс: +7 495 229-62-64.



E-mail: prescow@roche2.dia@roche.com


Кат. номер 09043292190

рибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным
м в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet FT4 IV cobas e
analyzer)



атор 1, FT4 4 Cal1: флакон, объем 1,0 мл, 2 шт.

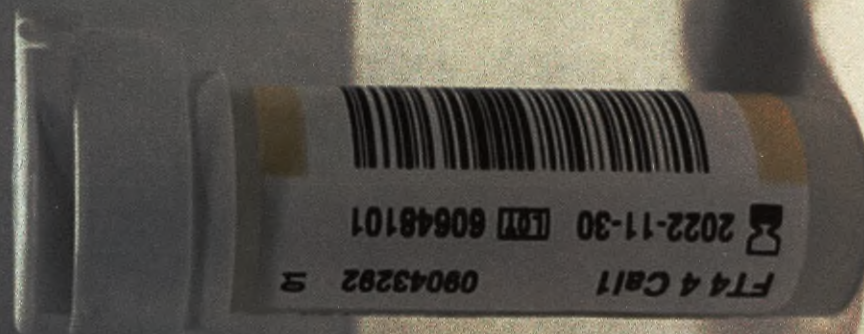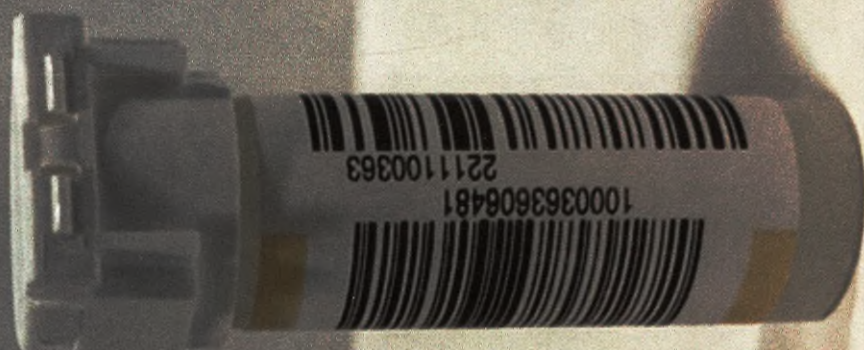

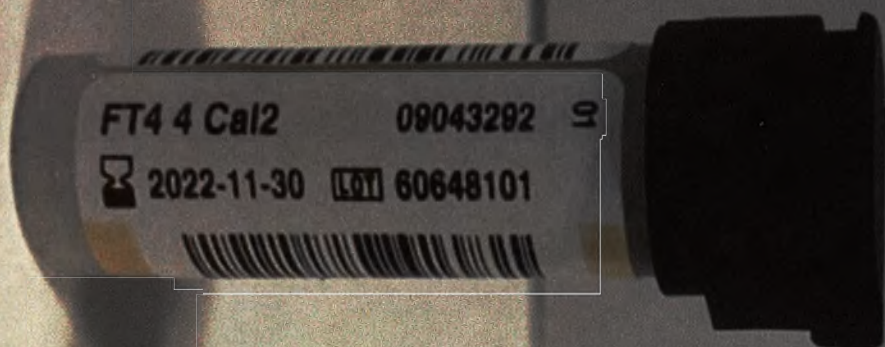

групп 2, FT4 4 Cal2: флакон, объем 1,0 мл, 2 шт.

FT4 4
CalSet

cobas e analyzers

09043292

2210

LOT 606481



01



для флаконов, 12 шт.

FT4 4 Cal1 09043292
2022-11-30 60648101



1208546606481
2211108546



FT4 4 Cal1 09043292
2022-11-30 60648101



1208546606481
2211108550



FT4 4 Cal1 09043292
2022-11-30 60648101



1208547606481
2211108548



FT4 4 Cal1 09043292
2022-11-30 60648101



1208546606481
2211108547



FT4 4 Cal1 09043292
2022-11-30 60648101



1208550606481
2211108551



FT4 4 Cal1 09043292
2022-11-30 60648101



1208546606481
2211108549



FT4 4 Cal2 09043292
2022-11-30 60648101



2208686606481
2211208687



FT4 4 Cal2 09043292
2022-11-30 60648101



2208684606481
2211208685



FT4 4 Cal2 09043292
2022-11-30 60648101



2208682606481
2211208683



FT4 4 Cal2 09043292
2022-11-30 60648101



2208687606481
2211208688



FT4 4 Cal2 09043292
2022-11-30 60648101



2208685606481
2211208686



FT4 4 Cal2 09043292
2022-11-30 60648101



2208683606481
2211208684





CalSet FT4 IV

REF 09043292190

4 x 1.0 ml



09043292190 V 1
dialog.roche.com

English

Precautions and warnings

For in vitro diagnostic use for health care professionals. Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.

Infectious or microbial waste:

Warning: handle waste as potentially biohazardous material. Dispose of waste according to accepted laboratory instructions and procedures.

Environmental hazards:

Apply all relevant local disposal regulations to determine the safe disposal.

Safety data sheet available for professional user on request.

This kit contains components classified as follows in accordance with the Regulation (EC) No. 1272/2008:



Warning:

H317 May cause an allergic skin reaction.

Prevention:

P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

P280 Wear protective gloves.

Response:

P333 + P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

P362 + P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Disposal:

P501 Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

Product safety labeling follows EU GHS guidance.

Contact phone: all countries: +49-621-7590

Avoid foam formation in all reagents and sample types (specimens, calibrators and controls).

Method Sheet download

The box at the top of this document shows the product code together with the respective document version.

Please go to dialog.roche.com to download this document.

The website displays either the version listed here or, if available, any later version that is also valid for this product code. If you have no internet access, please contact your local Roche affiliate to obtain the document free of charge.

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum durch medizinisches Fachpersonal. Die beim Umgang mit Laborreagenzien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Infektiöser oder mikrobieller Abfall:

Warnung: Abfall als potenziell biologisch gefährliches Material behandeln. Abfall im Einklang mit anerkannten Laboranweisungen und -verfahren entsorgen.

Umweltgefahren:

Zur Festlegung einer sicheren Entsorgung alle einschlägigen lokalen Entsorgungsvorschriften beachten.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

VIAT-cobas®

Die Packung enthält Bestandteile, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie folgt klassifiziert sind:



Warnung:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Prävention:

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

Reaktion:

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Entsorgung:

P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Die Produktsicherheitskennzeichnung folgt den in der EU gültigen GHS-Regulierungen.

Kontakt: Tel.-Nr. +49-621-7590 für alle Länder

Schaumbildung bei allen Reagenzien und Probenarten (Proben, Kalibratoren und Kontrollen) vermeiden.

Download von Methodenblättern

Der eingerahmte Text am Beginn des Dokumentes zeigt den Produkt-Code sowie die dazugehörige Version des Dokumentes. Dieses Dokument kann von der folgenden Webseite heruntergeladen werden: dialog.roche.com

Die Webseite zeigt die hier referenzierte Version oder aber, falls bereits verfügbar, eine ebenfalls für diesen Produkt-Code gültige höhere Version. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, erhalten Sie bei Ihrer Roche-Vertretung das Dokument kostenlos.

Français

Précautions d'emploi et mise en garde

Pour diagnostic in vitro, usage réservé aux professionnels de santé. Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire.

Déchets infectieux ou microbiens :

Mise en garde : Manipuler les déchets comme des matériaux potentiellement infectieux. Éliminer les déchets conformément aux instructions et aux procédures du laboratoire.

Risques environnementaux :

Suivre toutes les réglementations locales en vigueur pour une élimination en toute sécurité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Ce coffret contient des substances classées de la manière suivante selon le Règlement (CE) No. 1272/2008 :



Mise en garde

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Prévention :

2021-12, V 1

1/1

cobas e analyzers



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

10 листа (ов)



Кемлева А. С.

по доверенности

от 11.02.2022 г.