


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Реагенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), в вариантах исполнения

производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

агенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 200 тестов

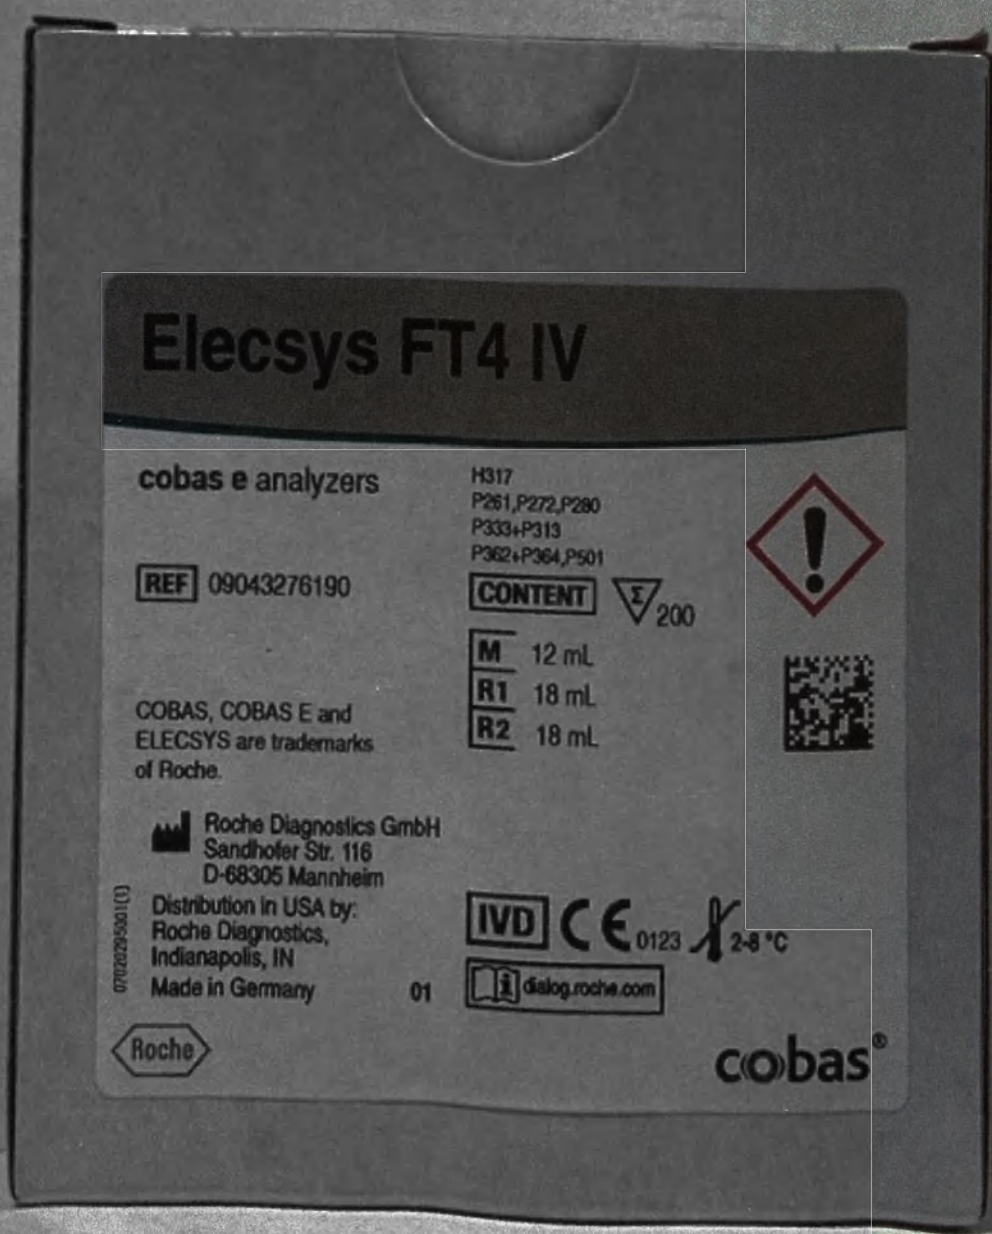

Elecsys FT4 IV

cobas e analyzers

REF 09043276190

COBAS, COBAS E and
ELECSYS are trademarks
of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

H317
P261,P272,P280
P333+P313
P362+P364,P501

CONTENT  200

M	12 mL
R1	18 mL
R2	18 mL



IVD **CE** 0123  2-8 °C


 dialog.roche.com

01



cobas[®]

тенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 200 тестов

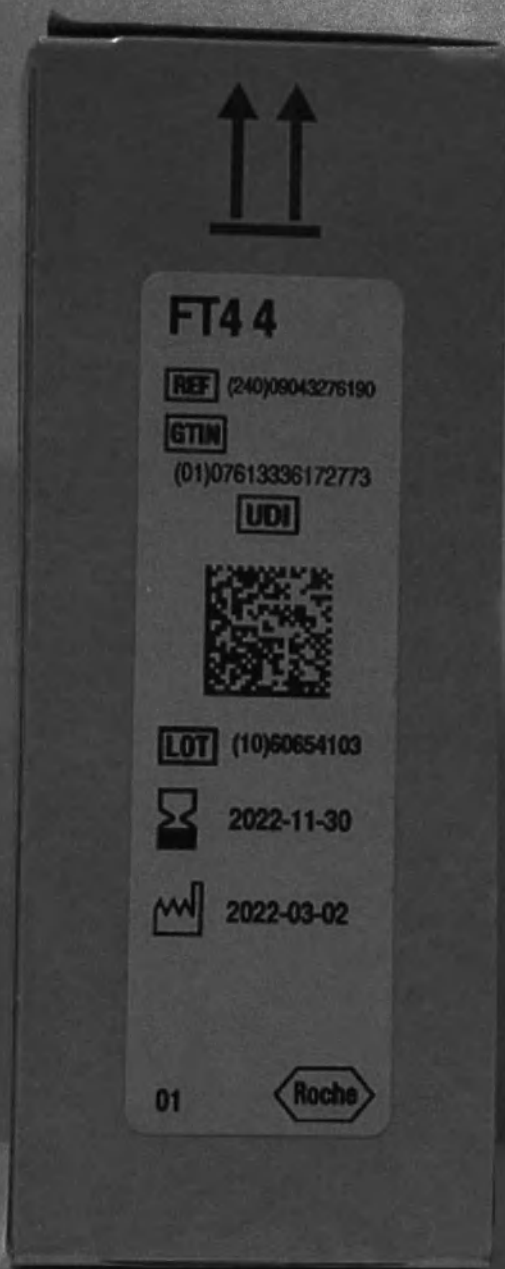

агенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 200 тестов

Elecsys FT4 IV

REF 09043276190

For USA: CONTENT

- Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1 Monoclonal anti-T4-antibody (rabbit) labeled with ruthenium complex 75 ng/mL
- R2 Biotinylated T4 2.5 ng/mL




Px only


01




тенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 200 тестов

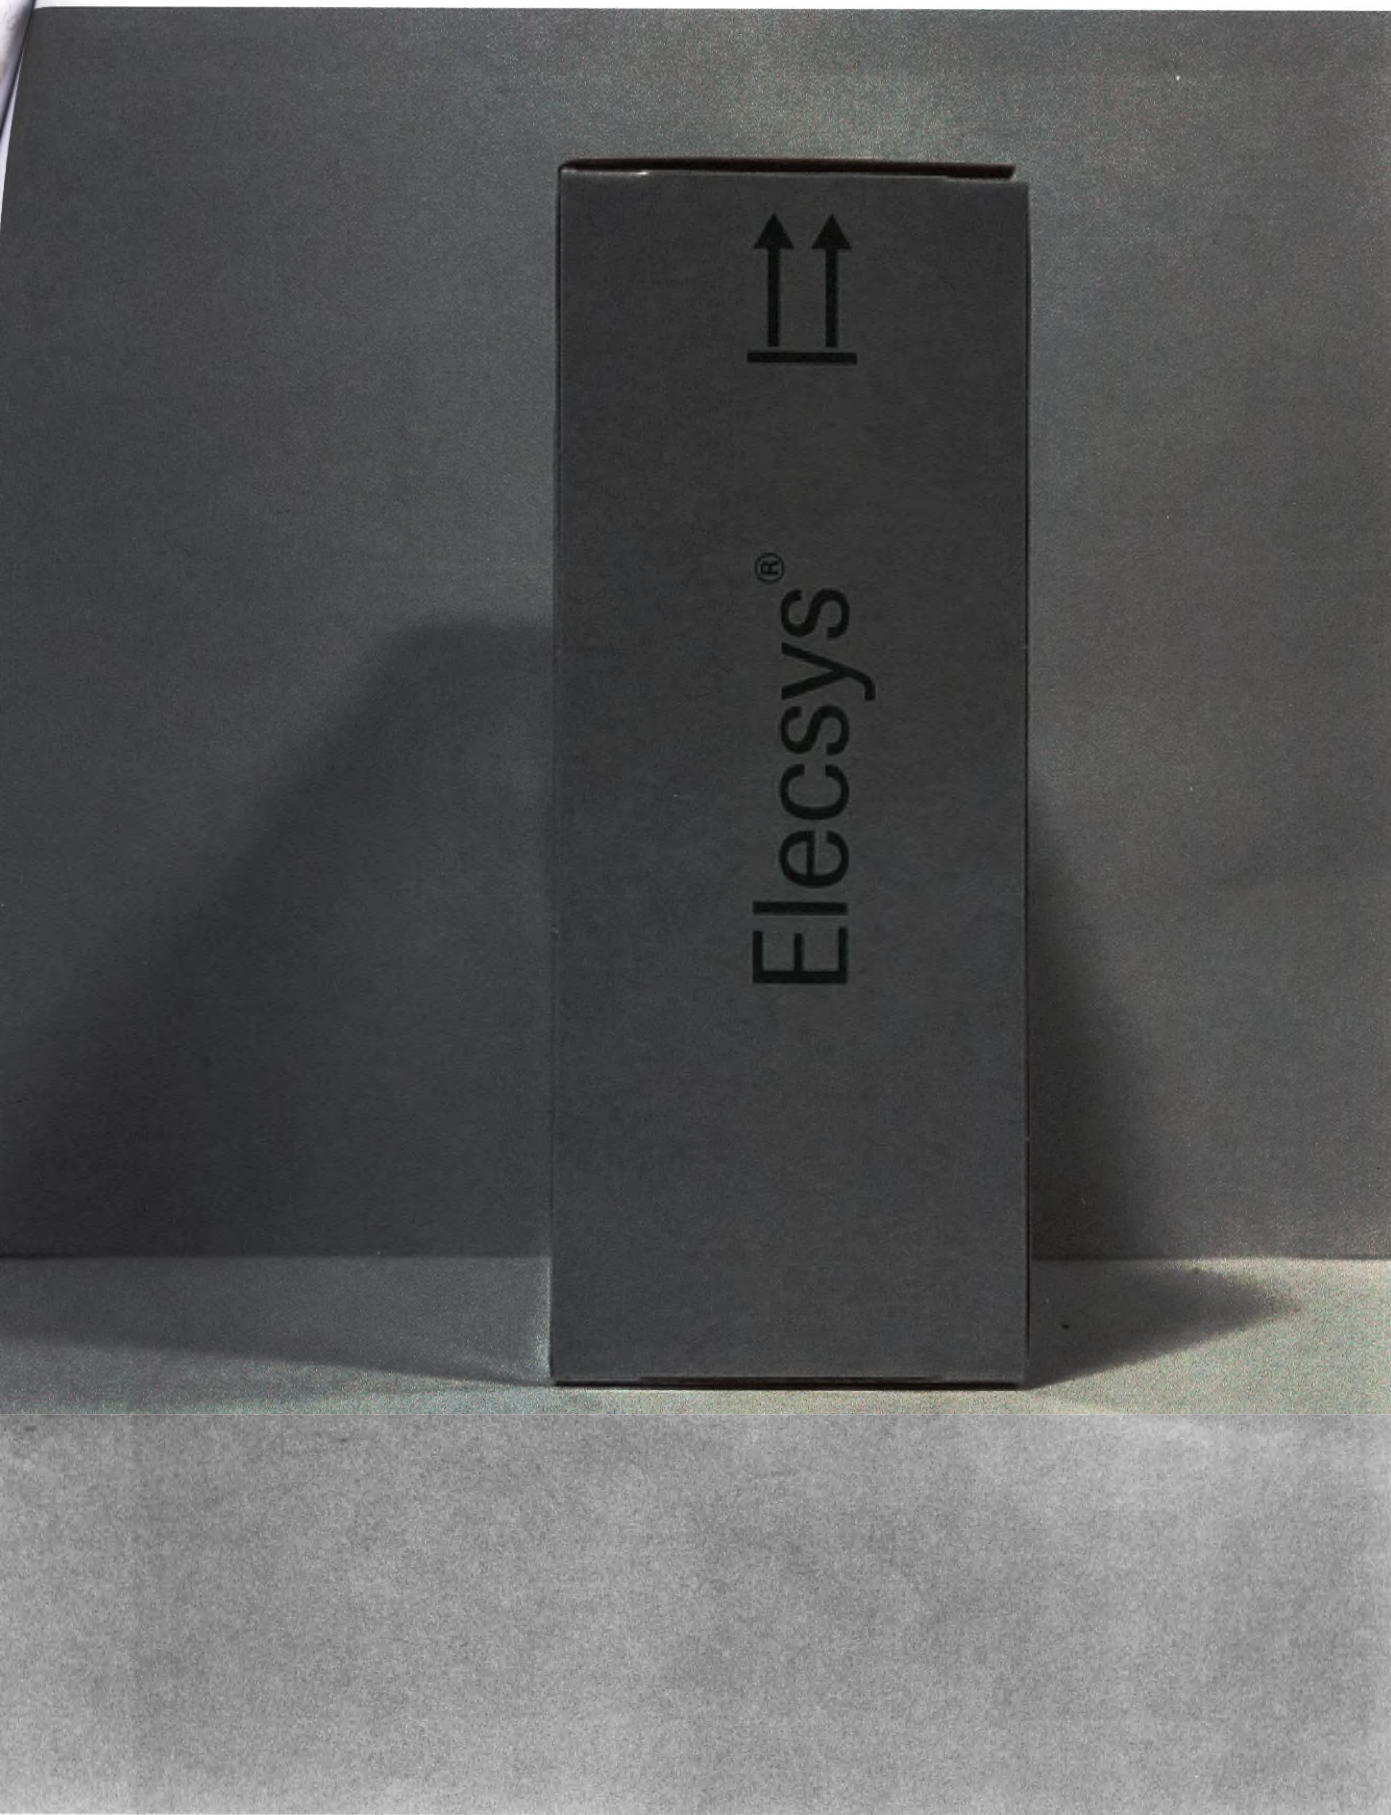

тенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 200 тестов

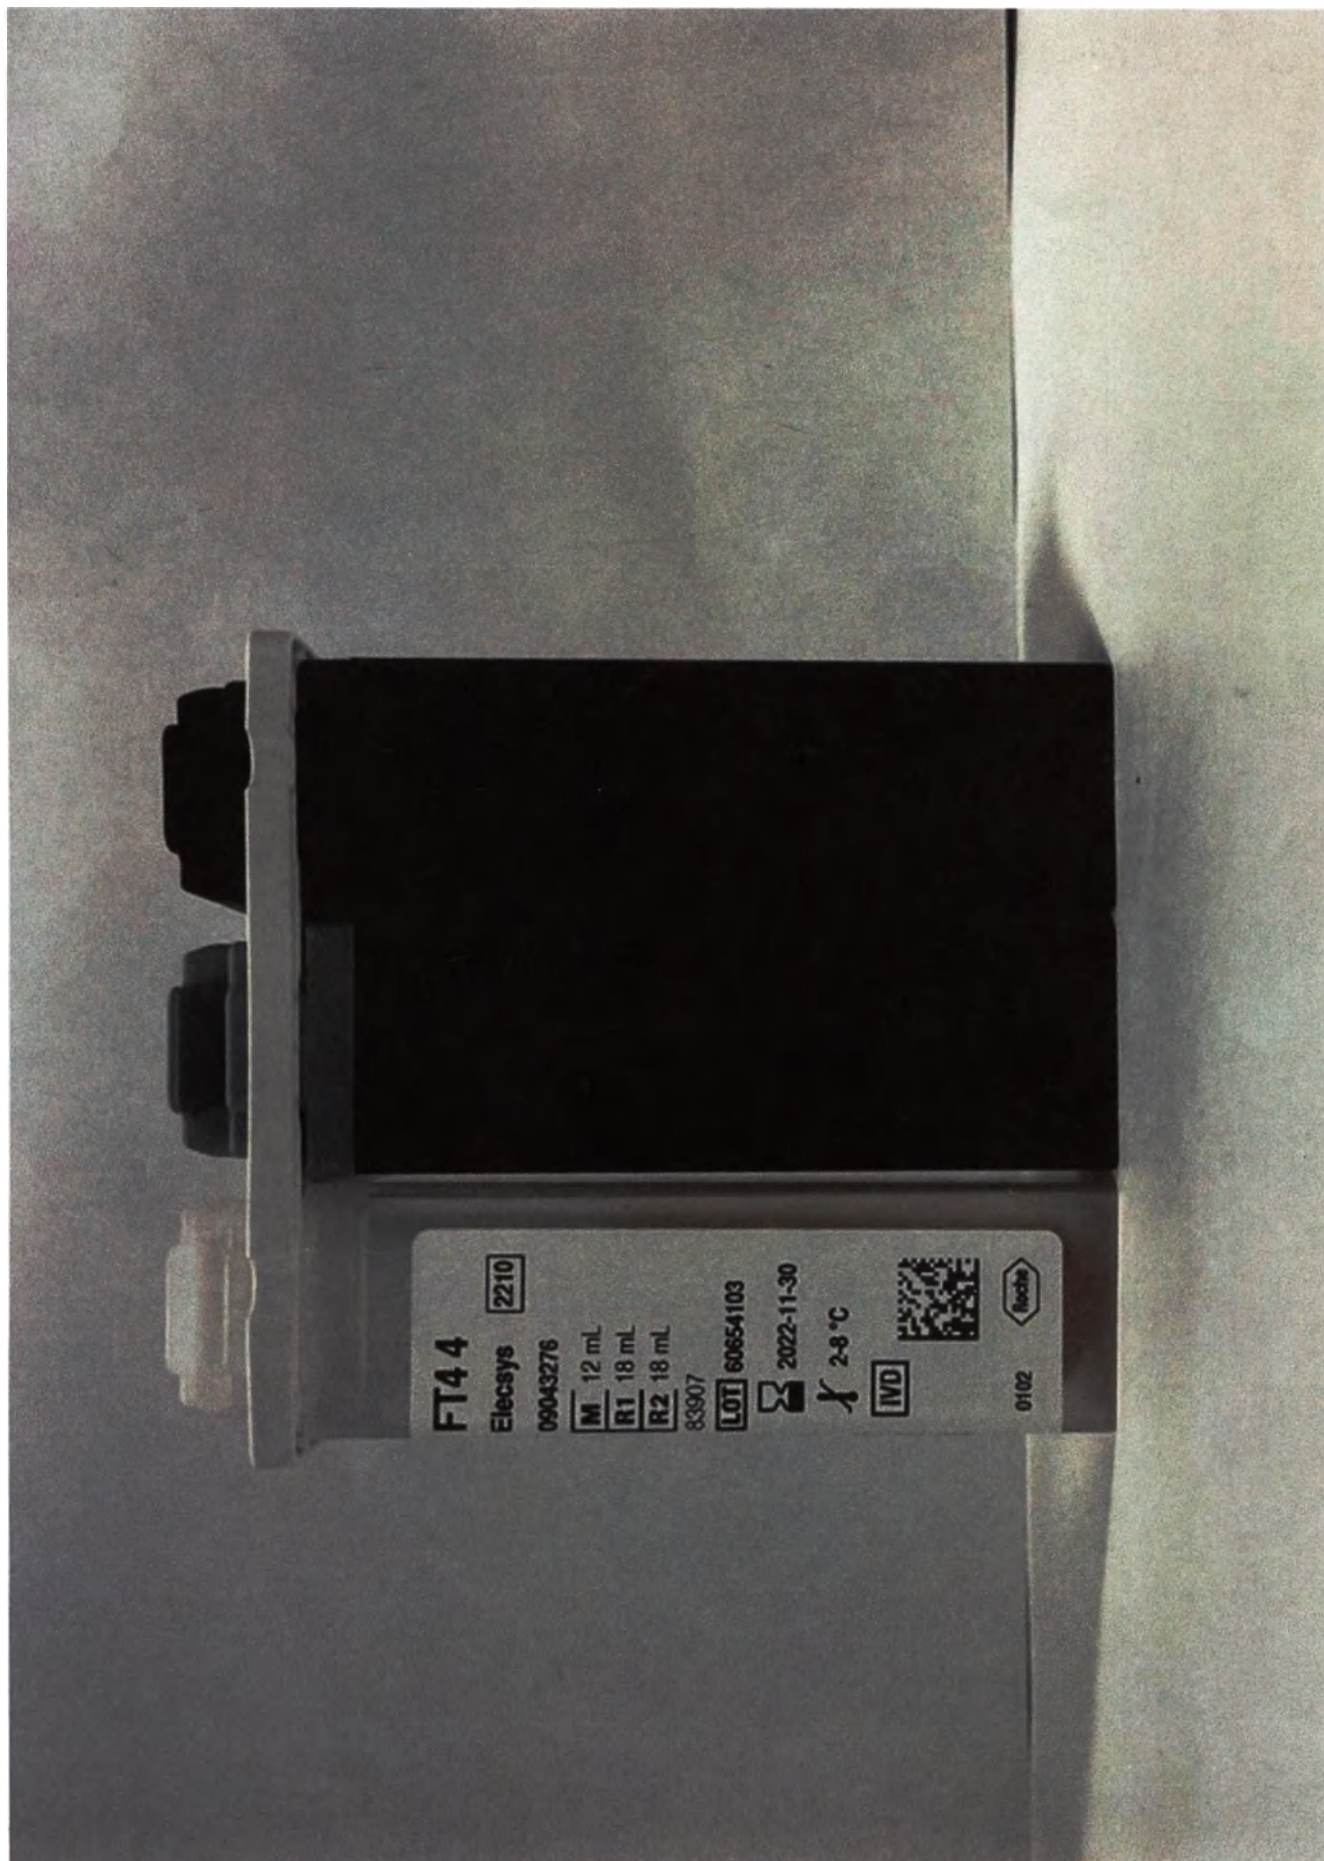

менты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 200 тестов

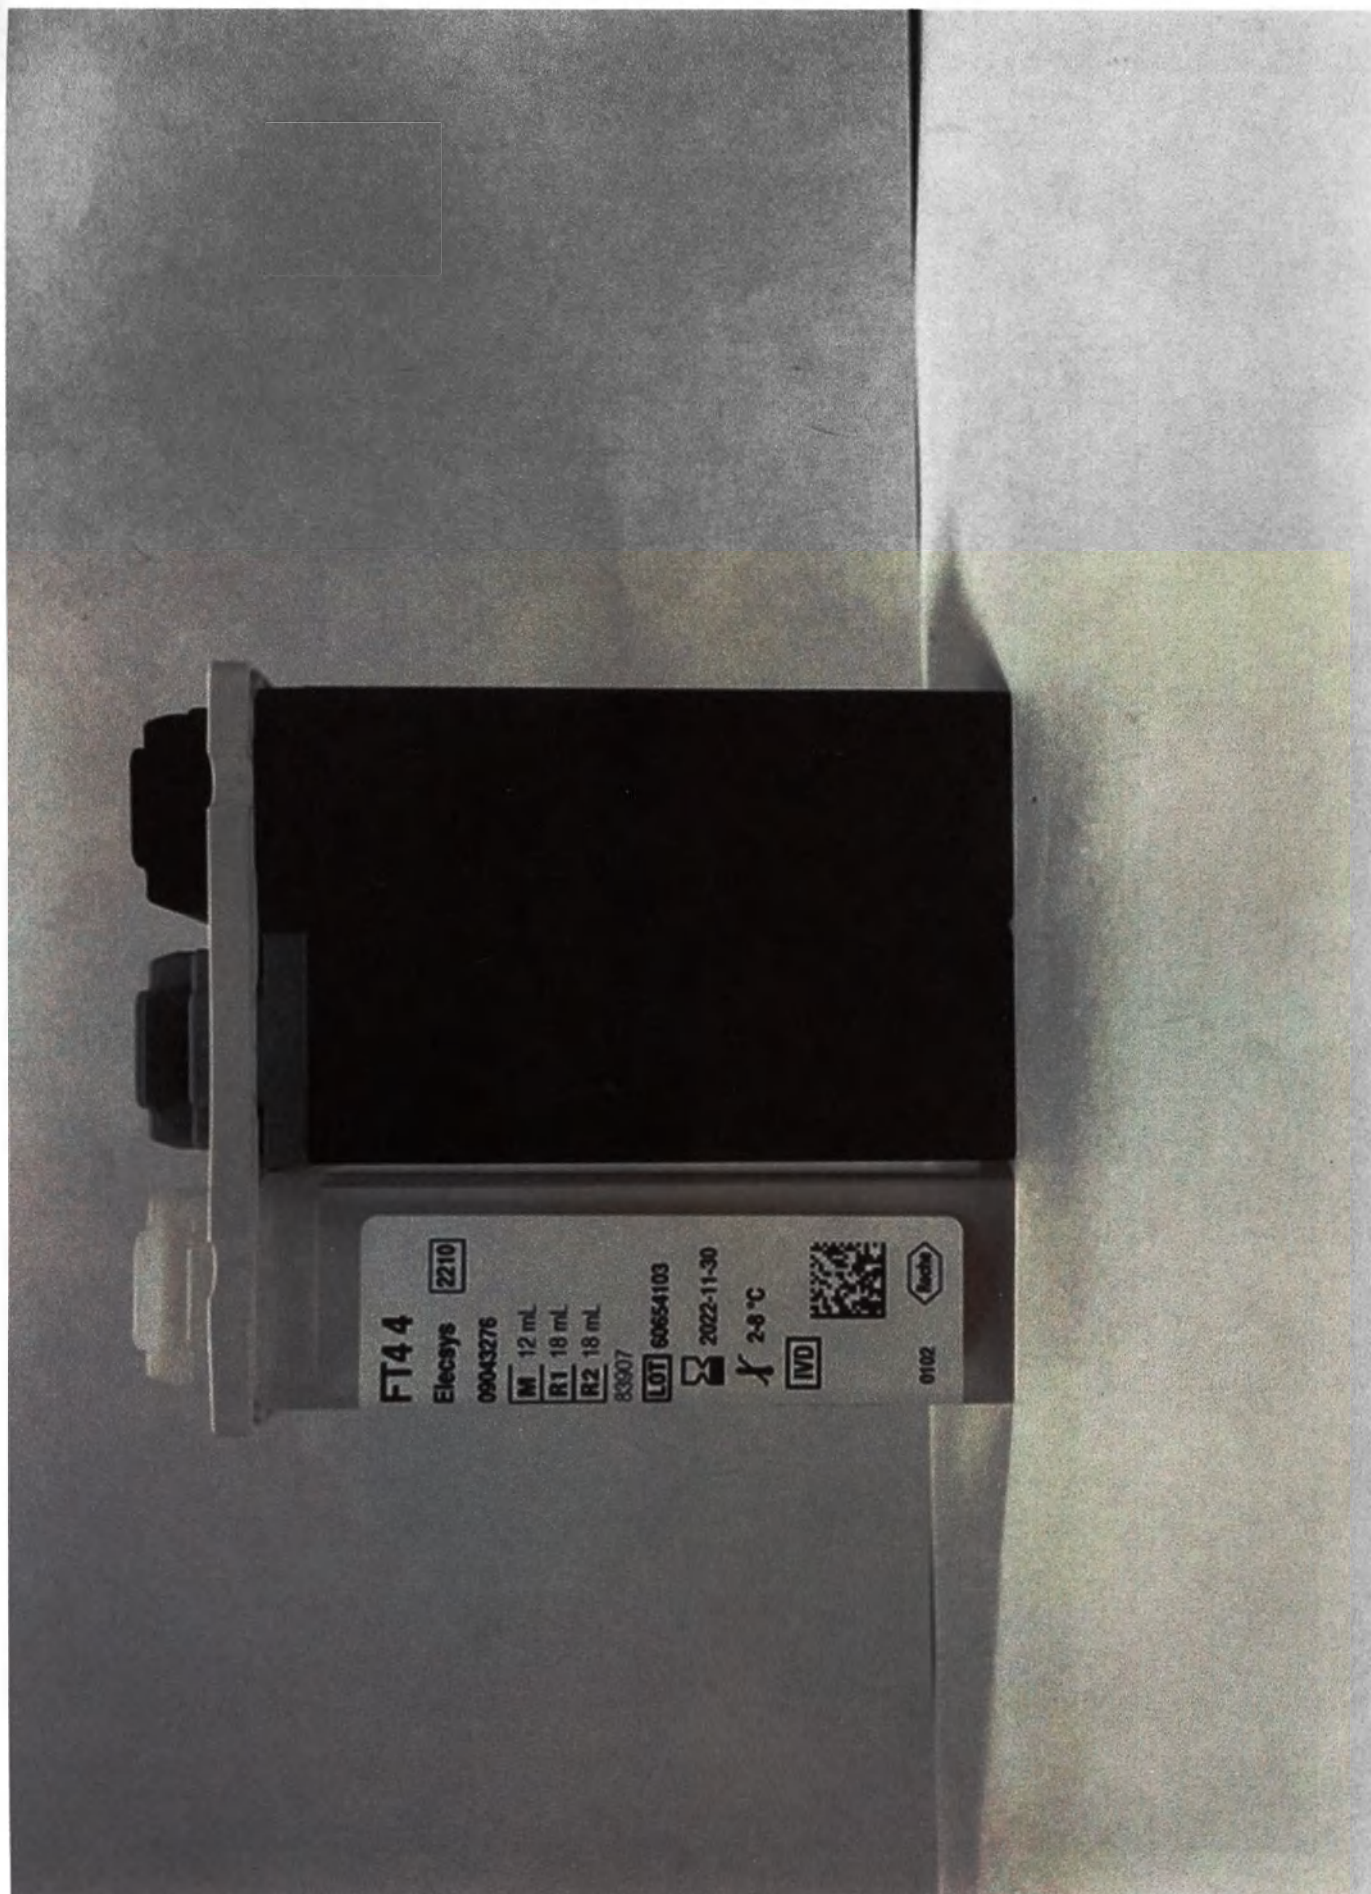

Результаты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 200 тестов

Результаты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 200 тестов.

Регистрационное удостоверение № ГЗН 2019/9060 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH», ("Roche Diagnostik GmbH", Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия)

Исследование предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.registration2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 09043276190

менты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 300 тестов

Elecsys FT4 IV

cobas e analyzers

H317
P261,P272,P280
P303+P313
P362+P364,P501



REF 09043284190

CONTENT 300

COBAS, COBAS E and
ELECSYS are trademarks
of Roche.

R1	19.7 mL
R2	19.7 mL
M	13.2 mL



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

(01/06/07/09/10)

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

01

IVD CE 0123 $\times$ 2-8 °C

 dialog.roche.com



cobas®

таты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas analyzers/FT4 4), вариант исполнения 300 тестов



тенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 300 тестов

Elecsys FT4 IV

REF 09043284190

For USA: CONTENT

- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1 Monoclonal anti-T4-antibody (rabbit) labeled with ruthenium complex 75 ng/mL
- R2 Biotinylated T4 2.5 ng/mL




Rx only


01



теты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным
дом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e
yzers/FT4 4), вариант исполнения 300 тестов

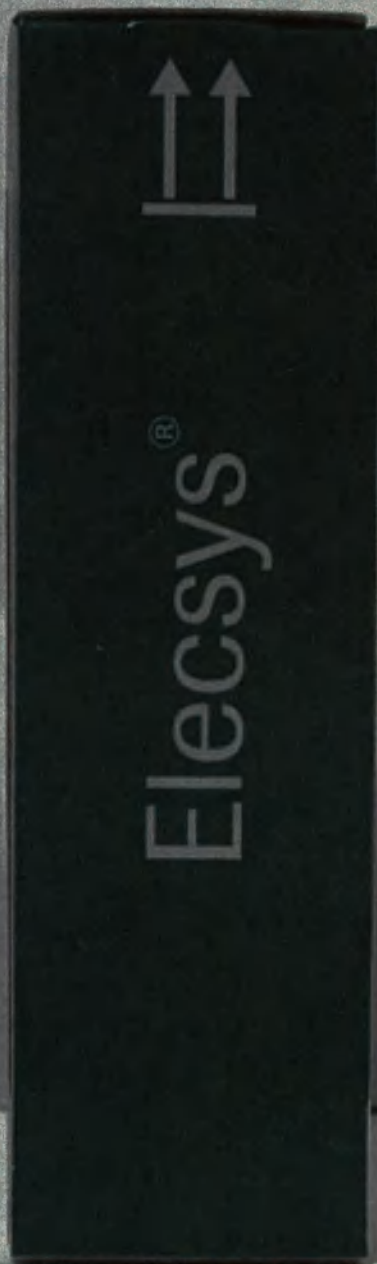


кассеты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 300 тестов

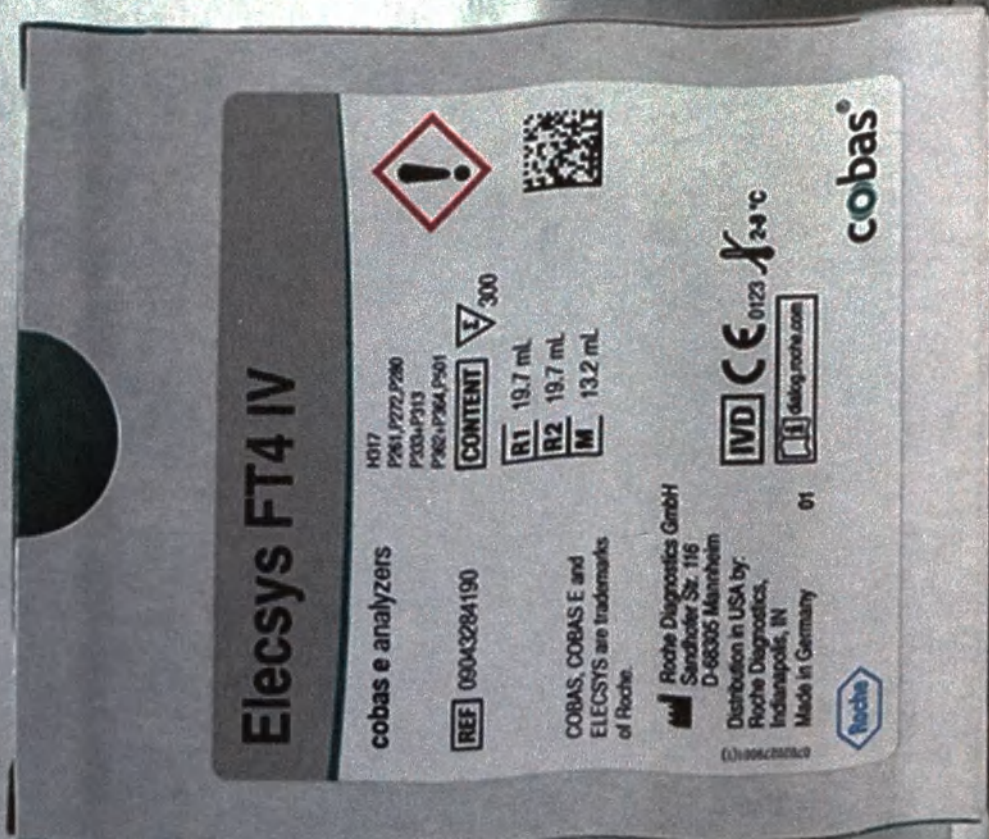

теты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 300 тестов



тенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 300 тестов

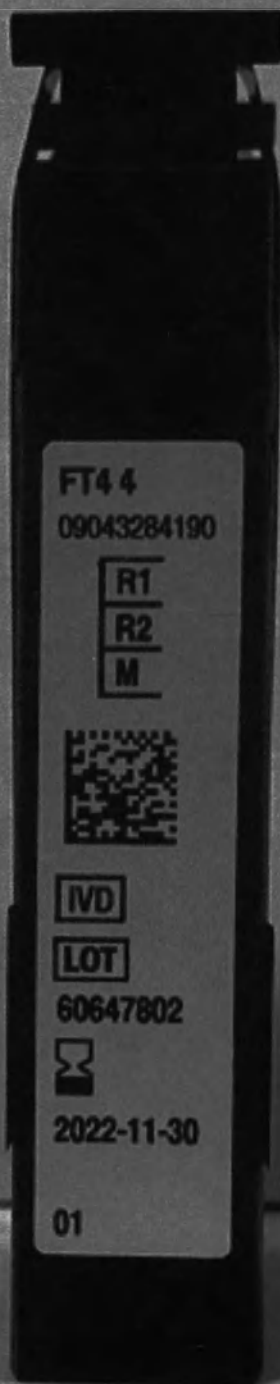

анты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 300 тестов

Реагенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys FT4 IV cobas e analyzers/FT4 4), вариант исполнения 300 тестов.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9860 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik GmbH", Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Саксони, Германия)

Назначение: предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: rosow.registration2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 09043284190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
16 листа (ов).



Кашкина А.А.

по доверенности
от 11.02.2022 г.