

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «биоМерье Рус»

Н.В. Бердникова

«27» 10 2022 г.




Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

«Набор реагентов «VIDAS SARS-COV-2 IgM (9COM)» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к штамму SARS-CoV-2 коронавируса в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного флуоресцентного анализа на анализаторах иммунологических семейства VIDAS»,
производства «биоМерье С.А.» (bioMérieux S.A.), Франция

Вторичная упаковка набора реагентов «VIDAS SARS-COV-2 IgM (9COM)» для качественного определения иммуноглобулинов класса М к штамму SARS-CoV-2 коронавируса в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного флуоресцентного анализа на анализаторах иммунологических семейства VIDAS




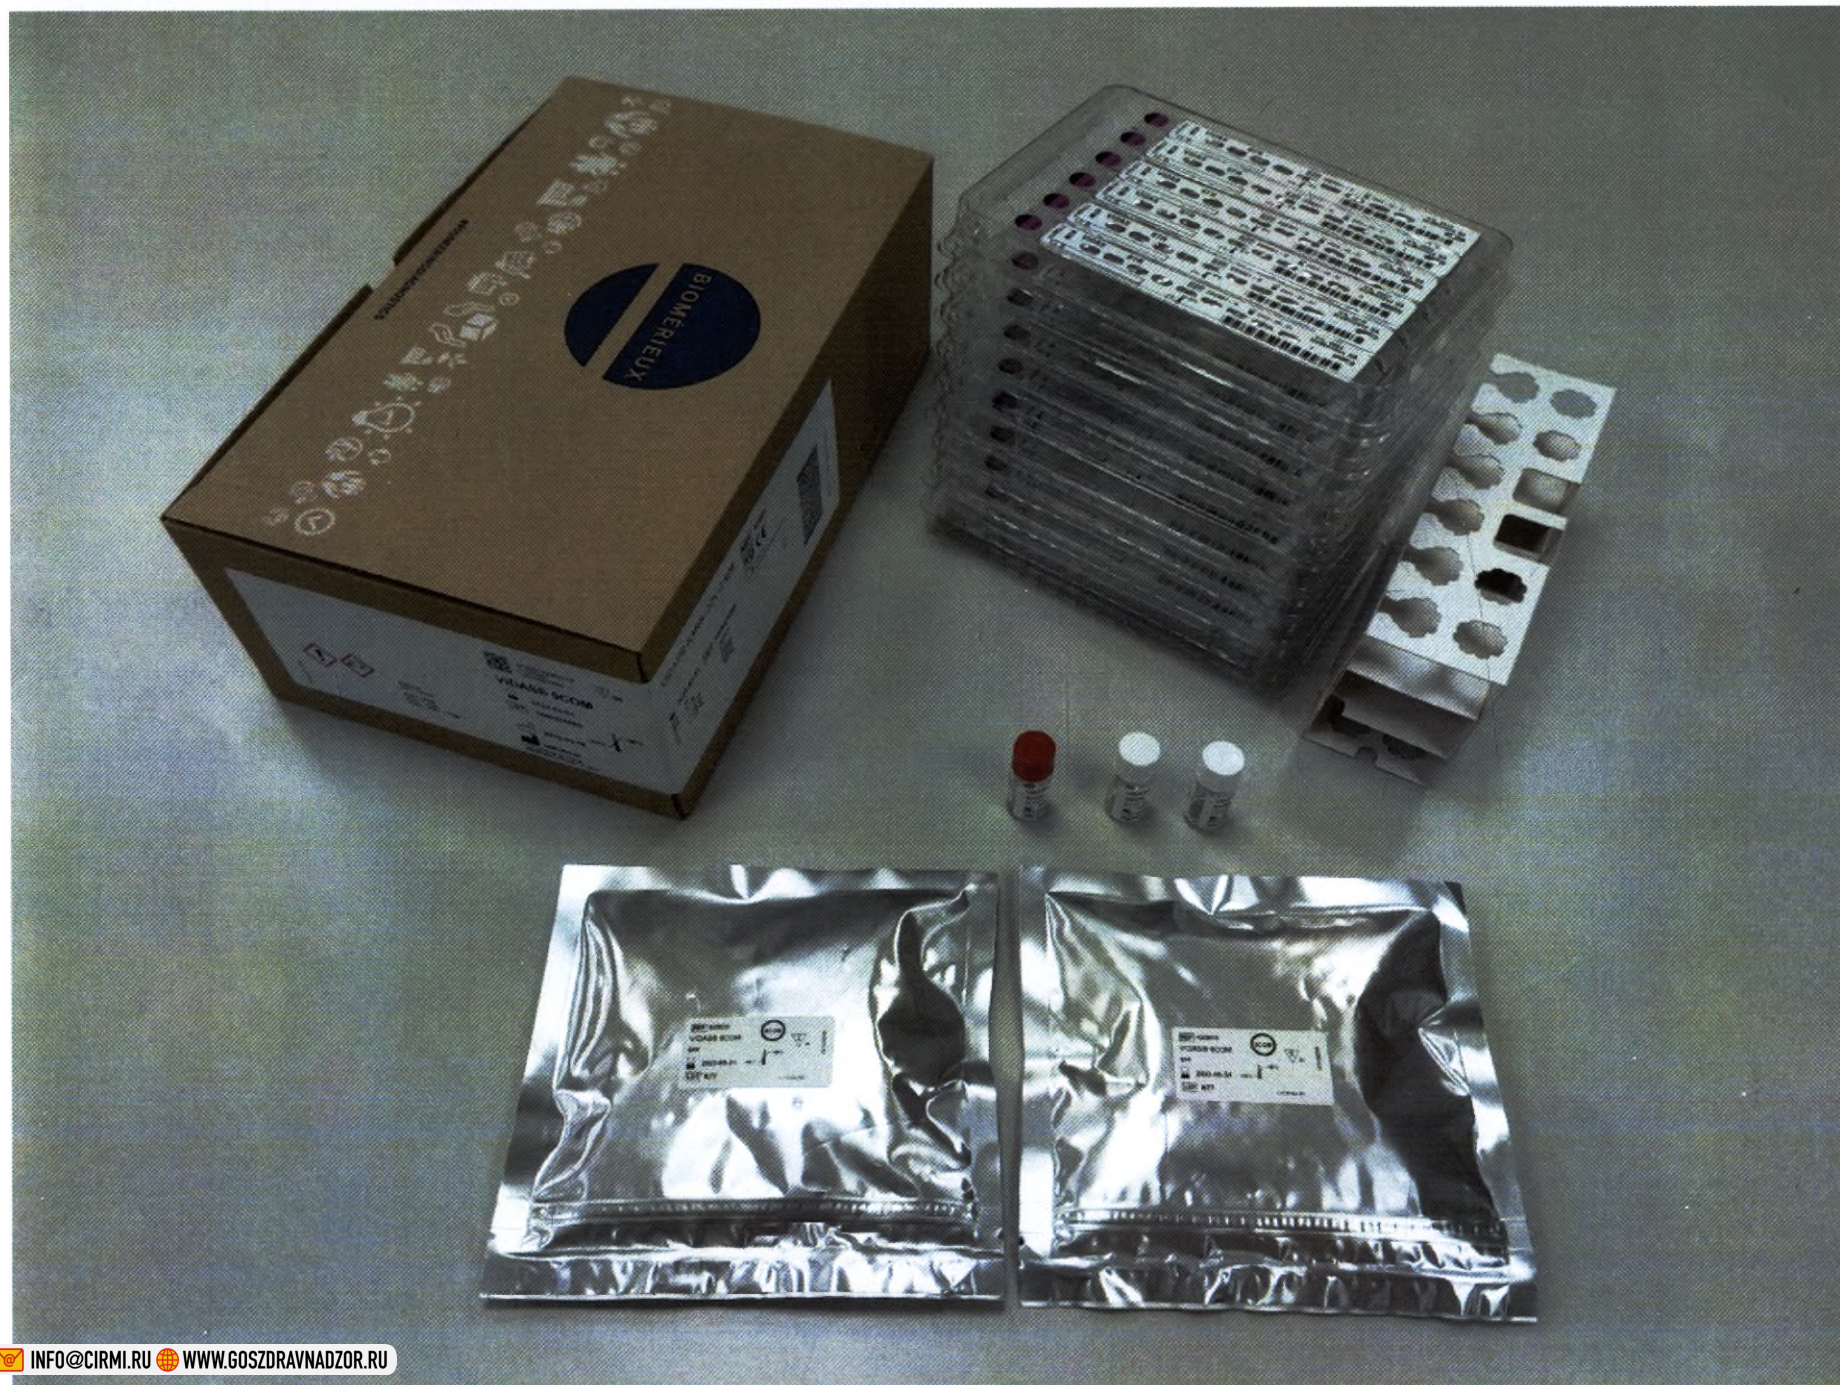


Стрипы 9COM (STR) – 60 штук




Наконечники 9COM (SPR), 30 шт./уп.- 2 упаковки

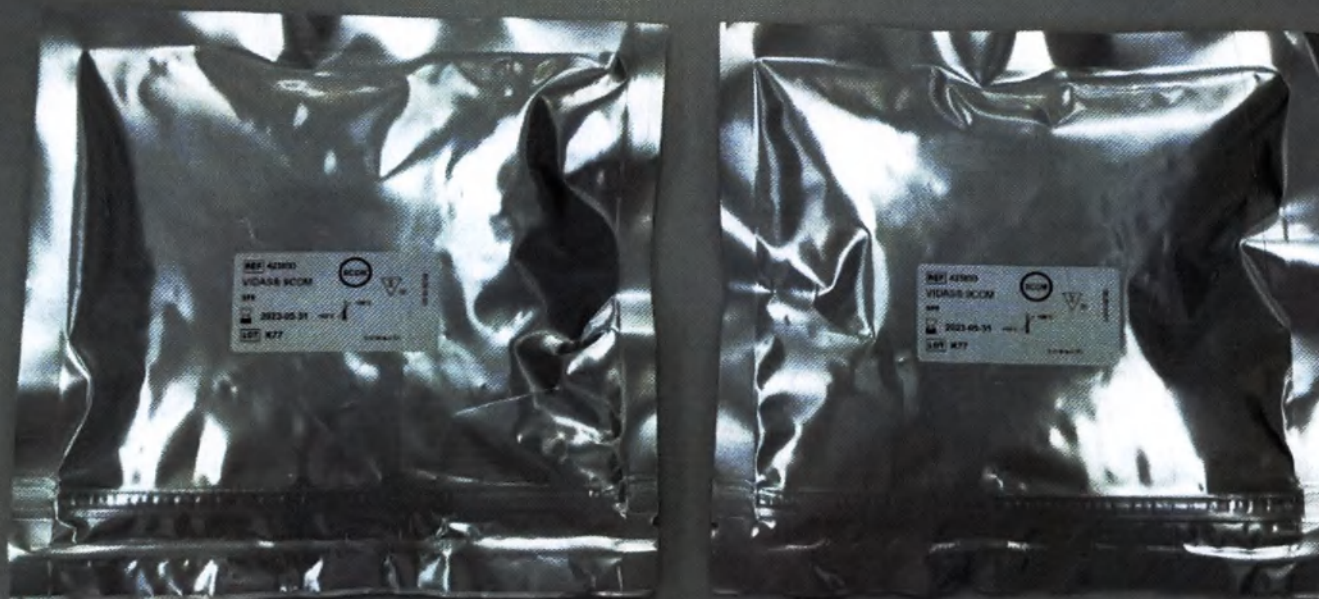


Стандарт калибровочный 9COM (S1) - 1 флакон х 0,5 мл (жидкий)

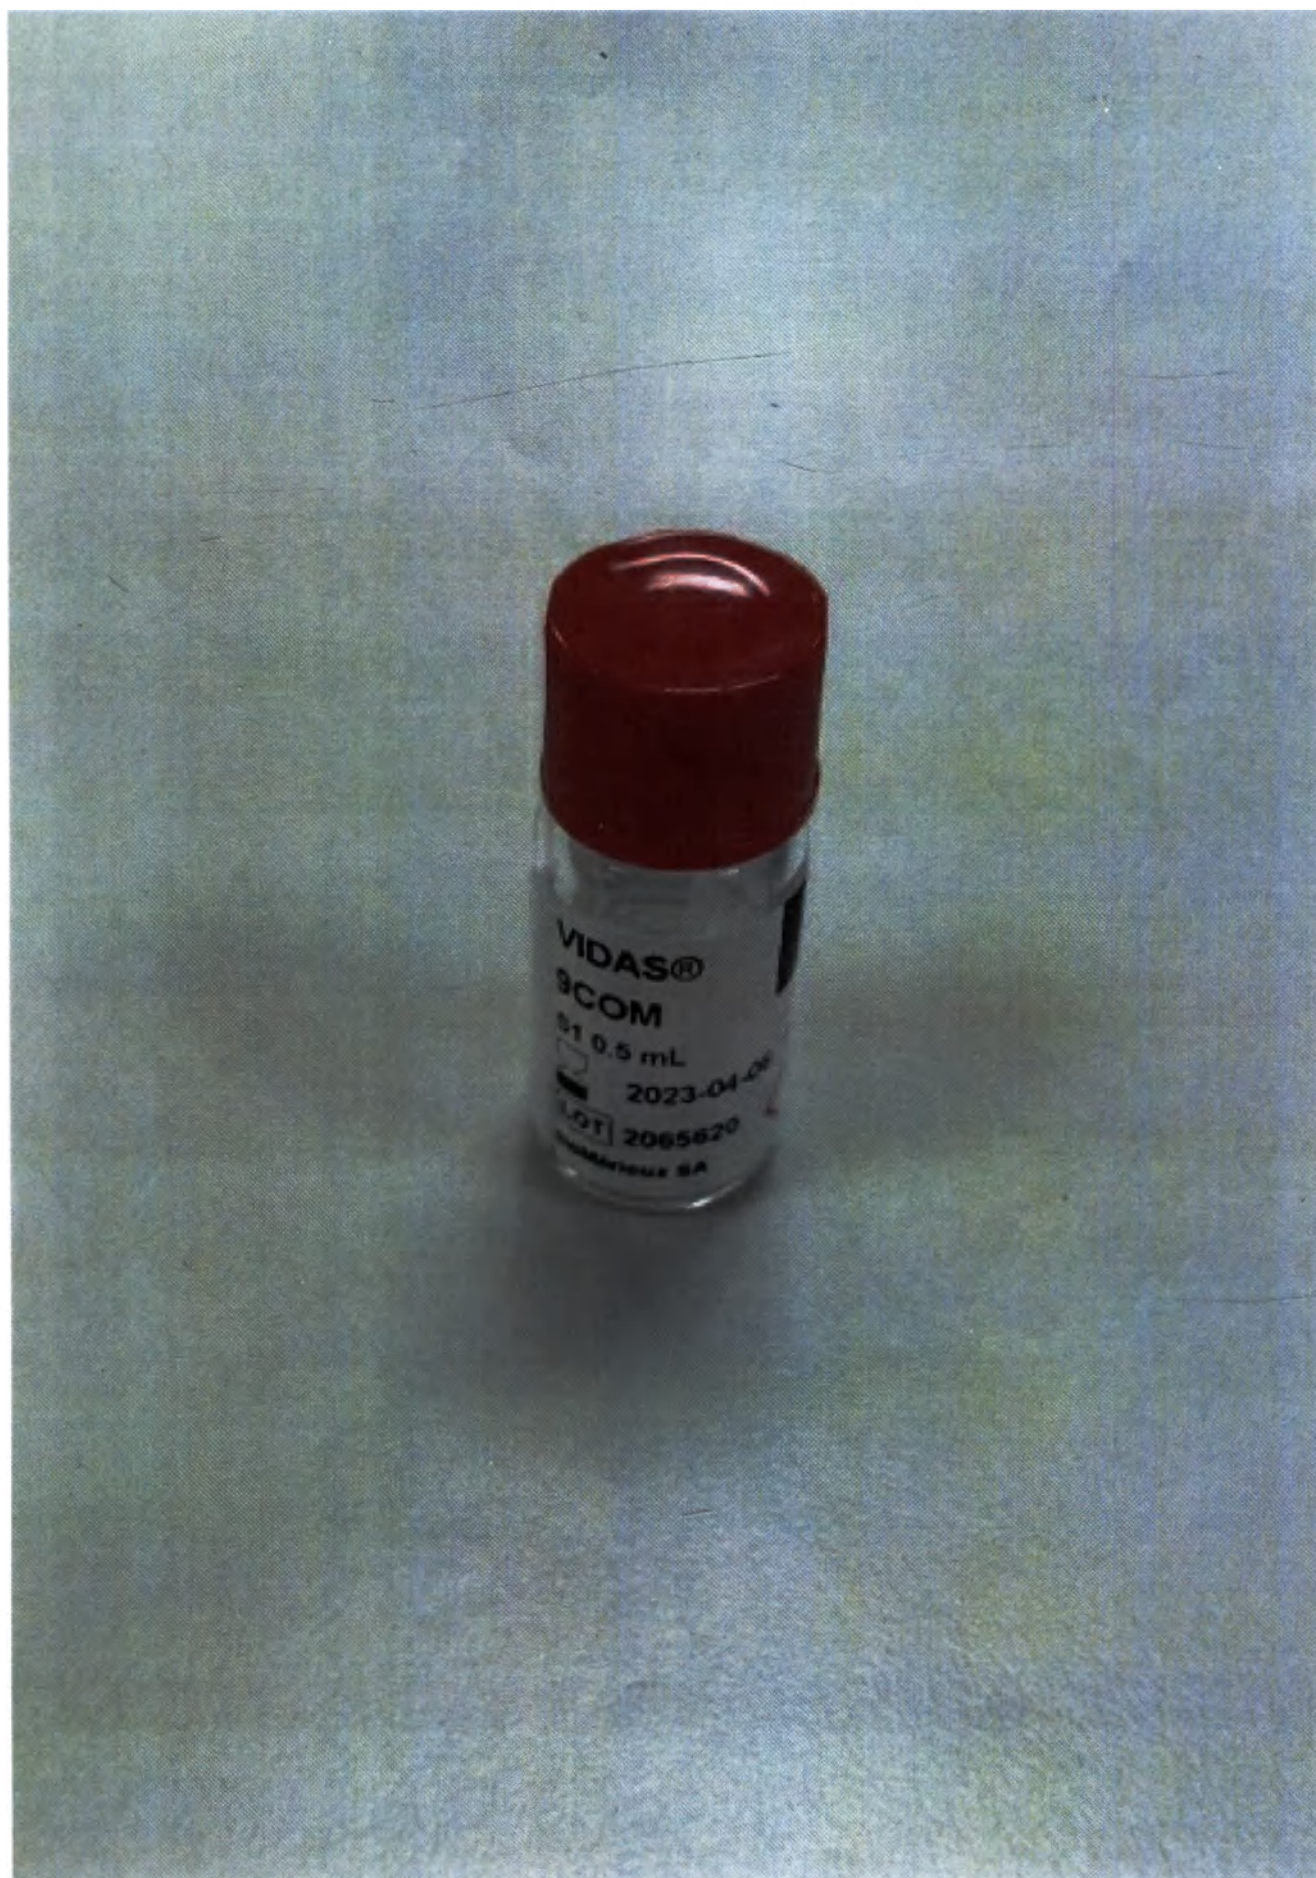

Контроль положительный 9СOM (C1) – 1 флакон х 0,5 мл (жидкий)

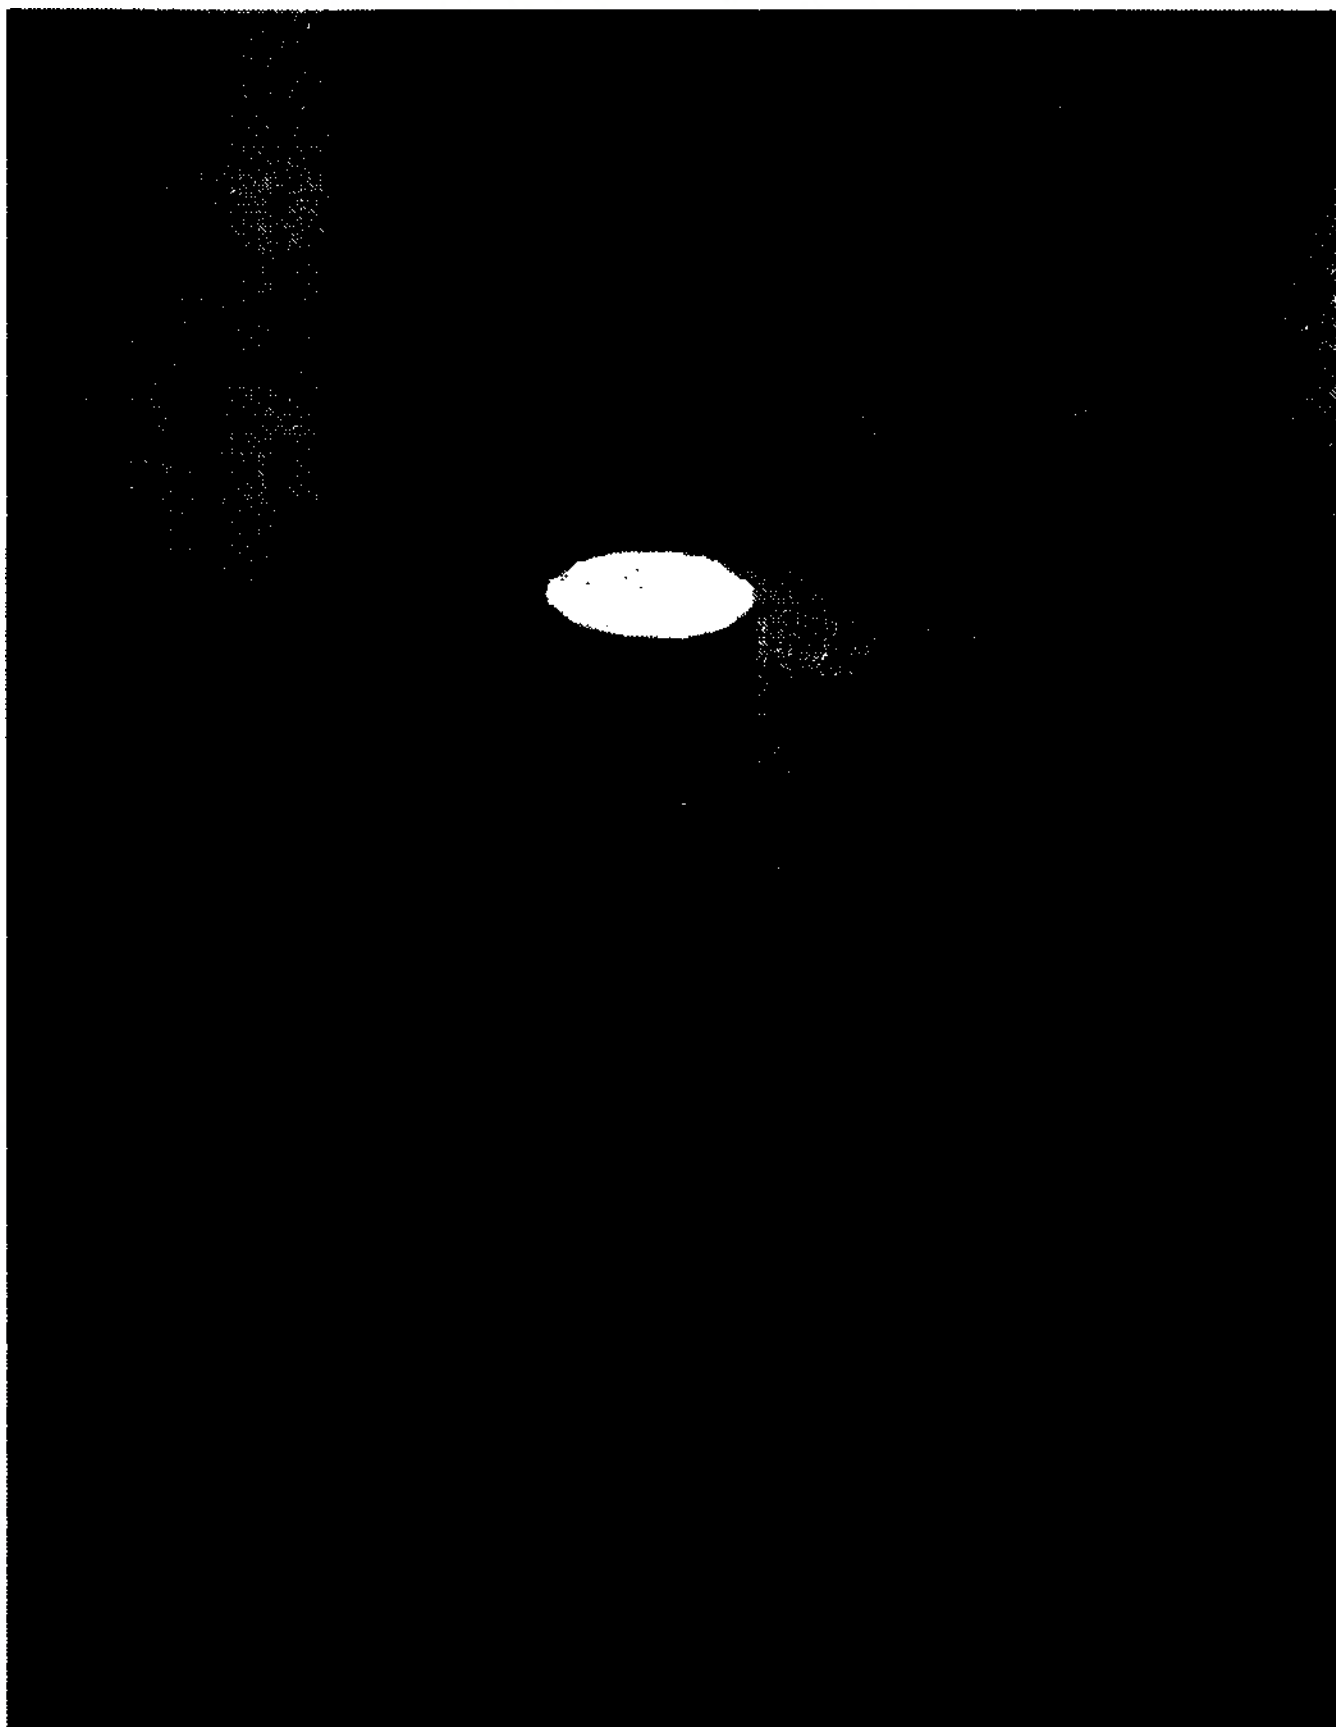

Контроль отрицательный 9COM (C2) – 1 флакон х 0,5 мл (жидкий)

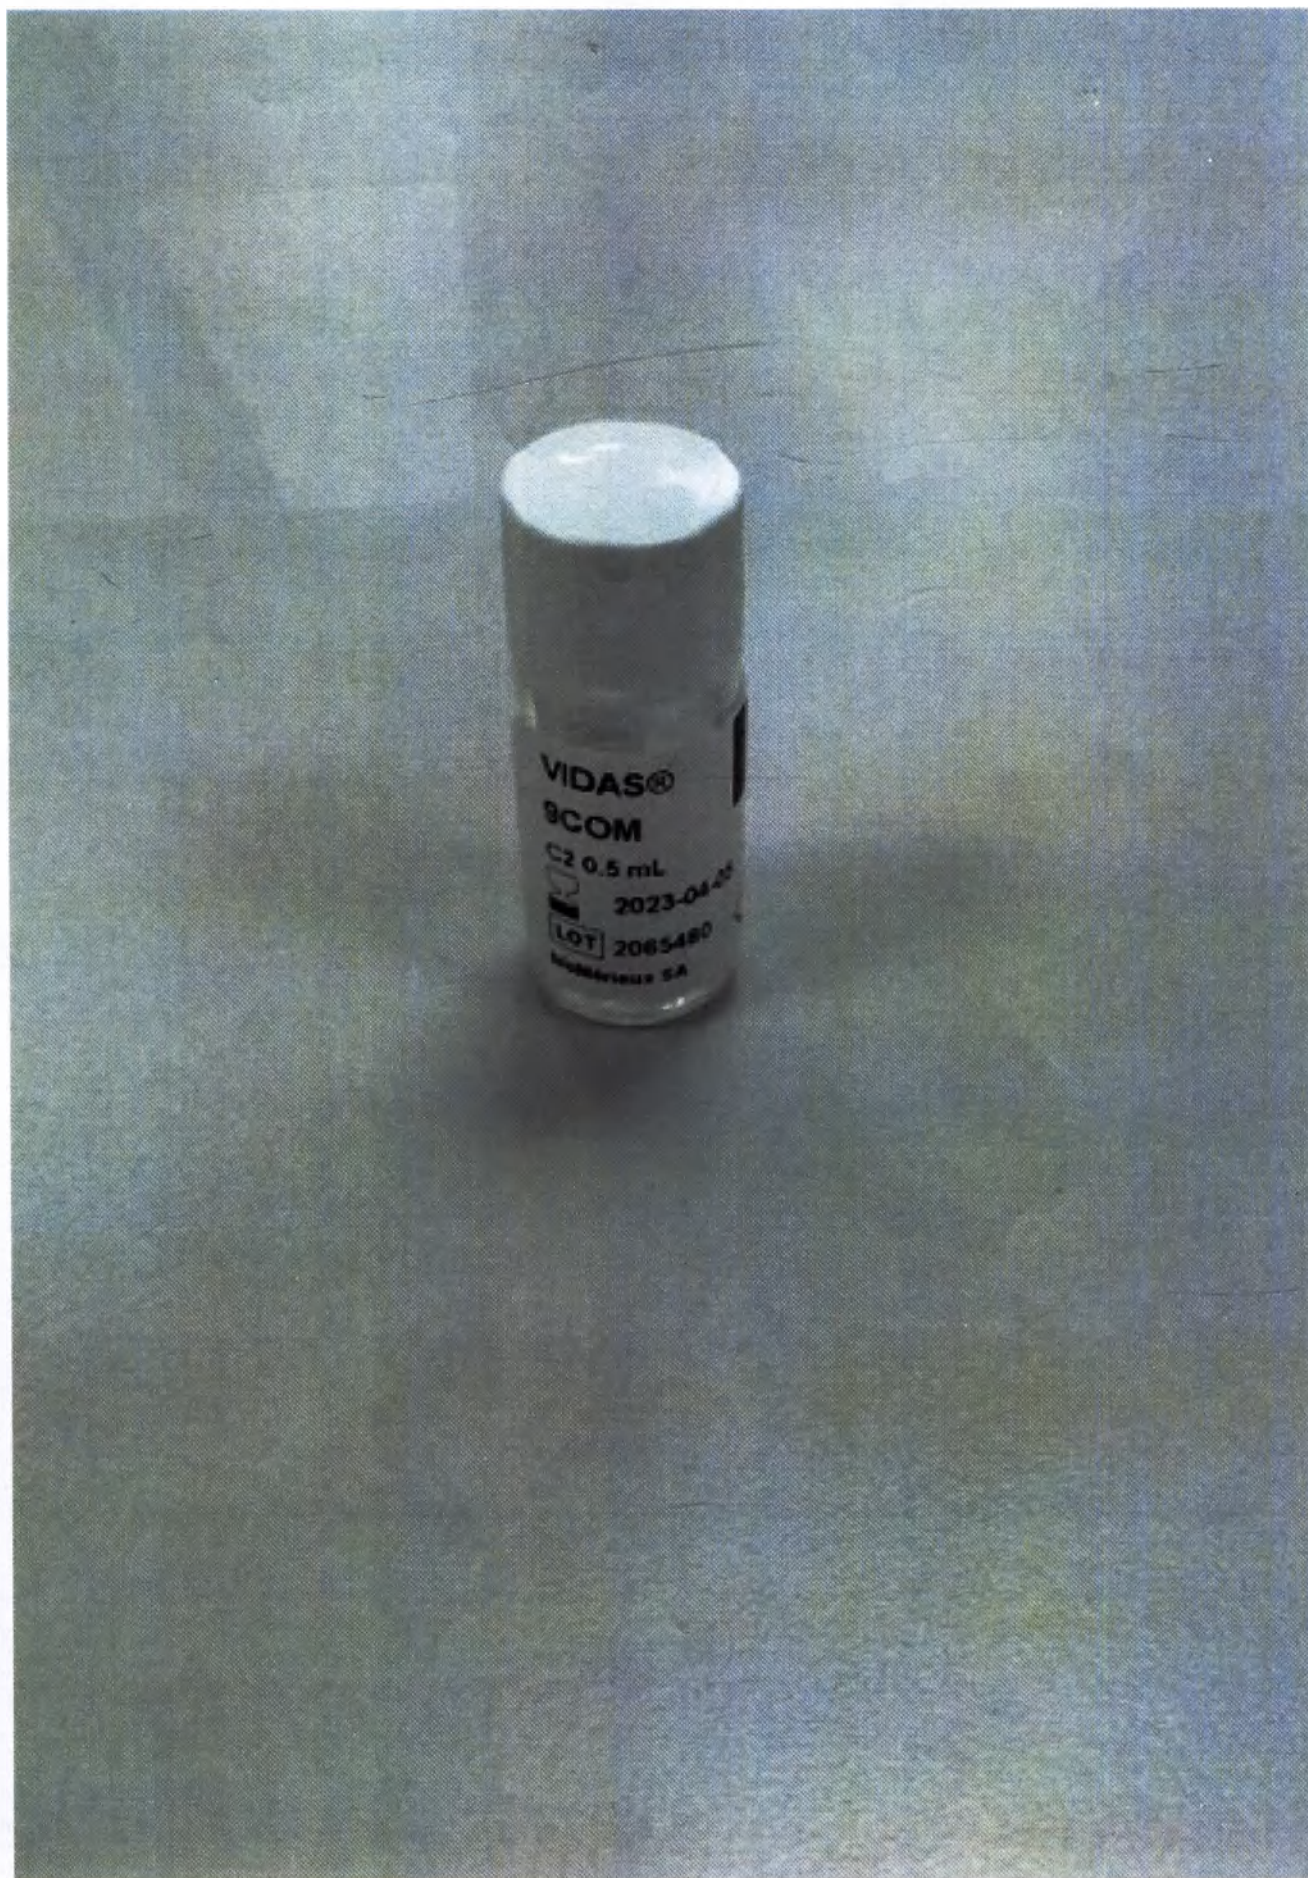

Прошито _____
пронумеровано 2 листов

«07 сентября 2022 г.

Генеральный директор
Бердникова Н.В.

