

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
Эстрадиол», по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

стр. 2,3,4

Вариант исполнения 2

стр. 5,6,7

Калибраторы 1,2,3,4

стр. 8,9,10,11

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

Кат. № 1400101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы
MagnoLIA Эстрадиол», по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

Кат. № 1400101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

LOT	E004		2022-08-03		
REF	1400101		2023-08-03		
IVD					

ТУ 21.20.23-619-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXX0000X

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778778; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол
Калибратор 1
Объем 1.0 мл

Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол
Калибратор 3
Объем 0.5 мл

Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол
Калибратор 4
Объем 1.0 мл

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

Кат. № 1400101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Биос»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

Кат. № 1400105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

Состав набора

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

ТУ 21.20.23-619-98539446-2022
РФ № ХХХХХХХХХХХХХХ

LOT E004

REF 1400105

IVD



2022-06-03



2023-06-03



30




Гипотеза к использованию:
Для профессионального применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы
MagnoLIA Эстрадиол», по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79
ПАСПОРТ № E004
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы Magnolia Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022
Кат. № 1400105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт

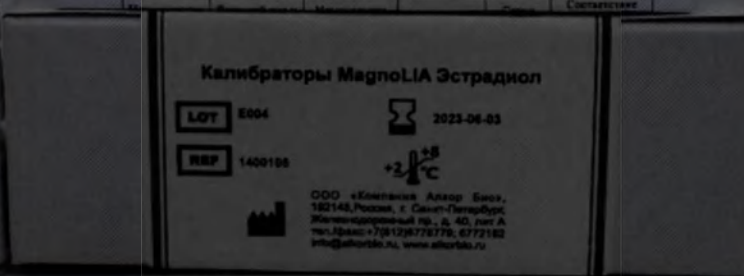

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E004


Набор реагентов для калибровки «Калибраторы Magnolia Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.13-619-98539446-2022

Кат. № 1400105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт





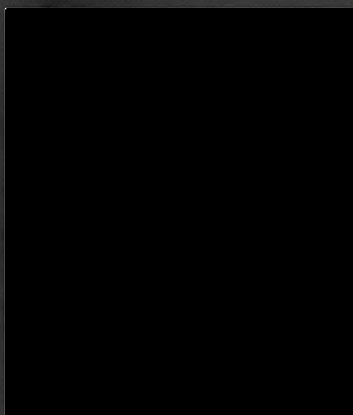

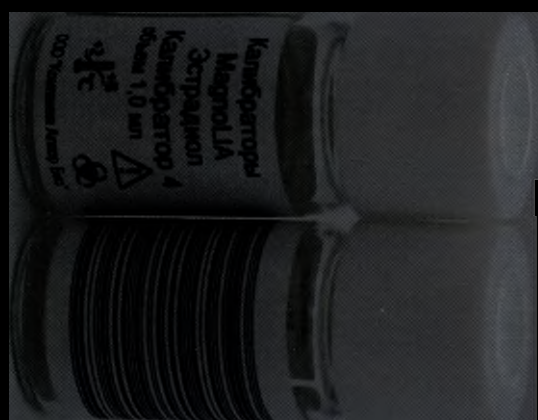

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (одинадцать) лист 86

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

_____ Д.Г. Полынцев



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
Эстрадиол», по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1400101

На коробку:



Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения



ТУ 21 20 23-619-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
Эстрадиол
Калибратор 1
объем 1,0 мл
+25°C
000 "Компания Алкор Био"



Калибраторы
MagnoLIA
Эстрадиол
Калибратор 2
объем 0,5 мл
+25°C
000 "Компания Алкор Био"



Калибраторы
MagnoLIA
Эстрадиол
Калибратор 3
объем 0,5 мл
+25°C
000 "Компания Алкор Био"



Калибраторы
MagnoLIA
Эстрадиол
Калибратор 4
объем 1,0 мл
+25°C
000 "Компания Алкор Био"



Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1400105

На коробку:



Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол»,
по ТУ 21.20.23-619-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E004
REF 1400105
IVD

2022-06-03
2023-06-03
50

+2⁺8
+2⁺8
!

Биологическая опасность



ТУ 21.20.23-619-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX


Готово к использованию.
Для профессионального применения.

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр. д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6787778, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Калибраторы MagnoLIA Эстрадиол
LOT E004
REF 1400105
IVD


На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
Эстрадиол
Калибратор 1
объем 1,0 мл




- 5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
Эстрадиол
Калибратор 2
объем 0,5 мл




- 5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
Эстрадиол
Калибратор 3
объем 0,5 мл



- 5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
Эстрадиол
Калибратор 4
объем 1,0 мл



- 5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ТМ) листа а

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Т. Полинцев

