

Фотографические изображения
медицинского изделия

*Система интервенционная ангиографическая
Alphenix модели INFx-8000V/Y
с принадлежностями*

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АрПи Канон Медикал Системз»

Чередниченко Д.В.

« 23 » ноября



Система кардиологическая SP интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями.

Основной состав: 1. Напольный опорный модуль С-дуги модели CAS-880A.




2. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, в вариантах исполнения: - модель BLA-900C




2. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, в вариантах исполнения: - модель BLA-900C/R1




3. Узел рентгеновской трубки, модель DSRX-T7444GDS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).

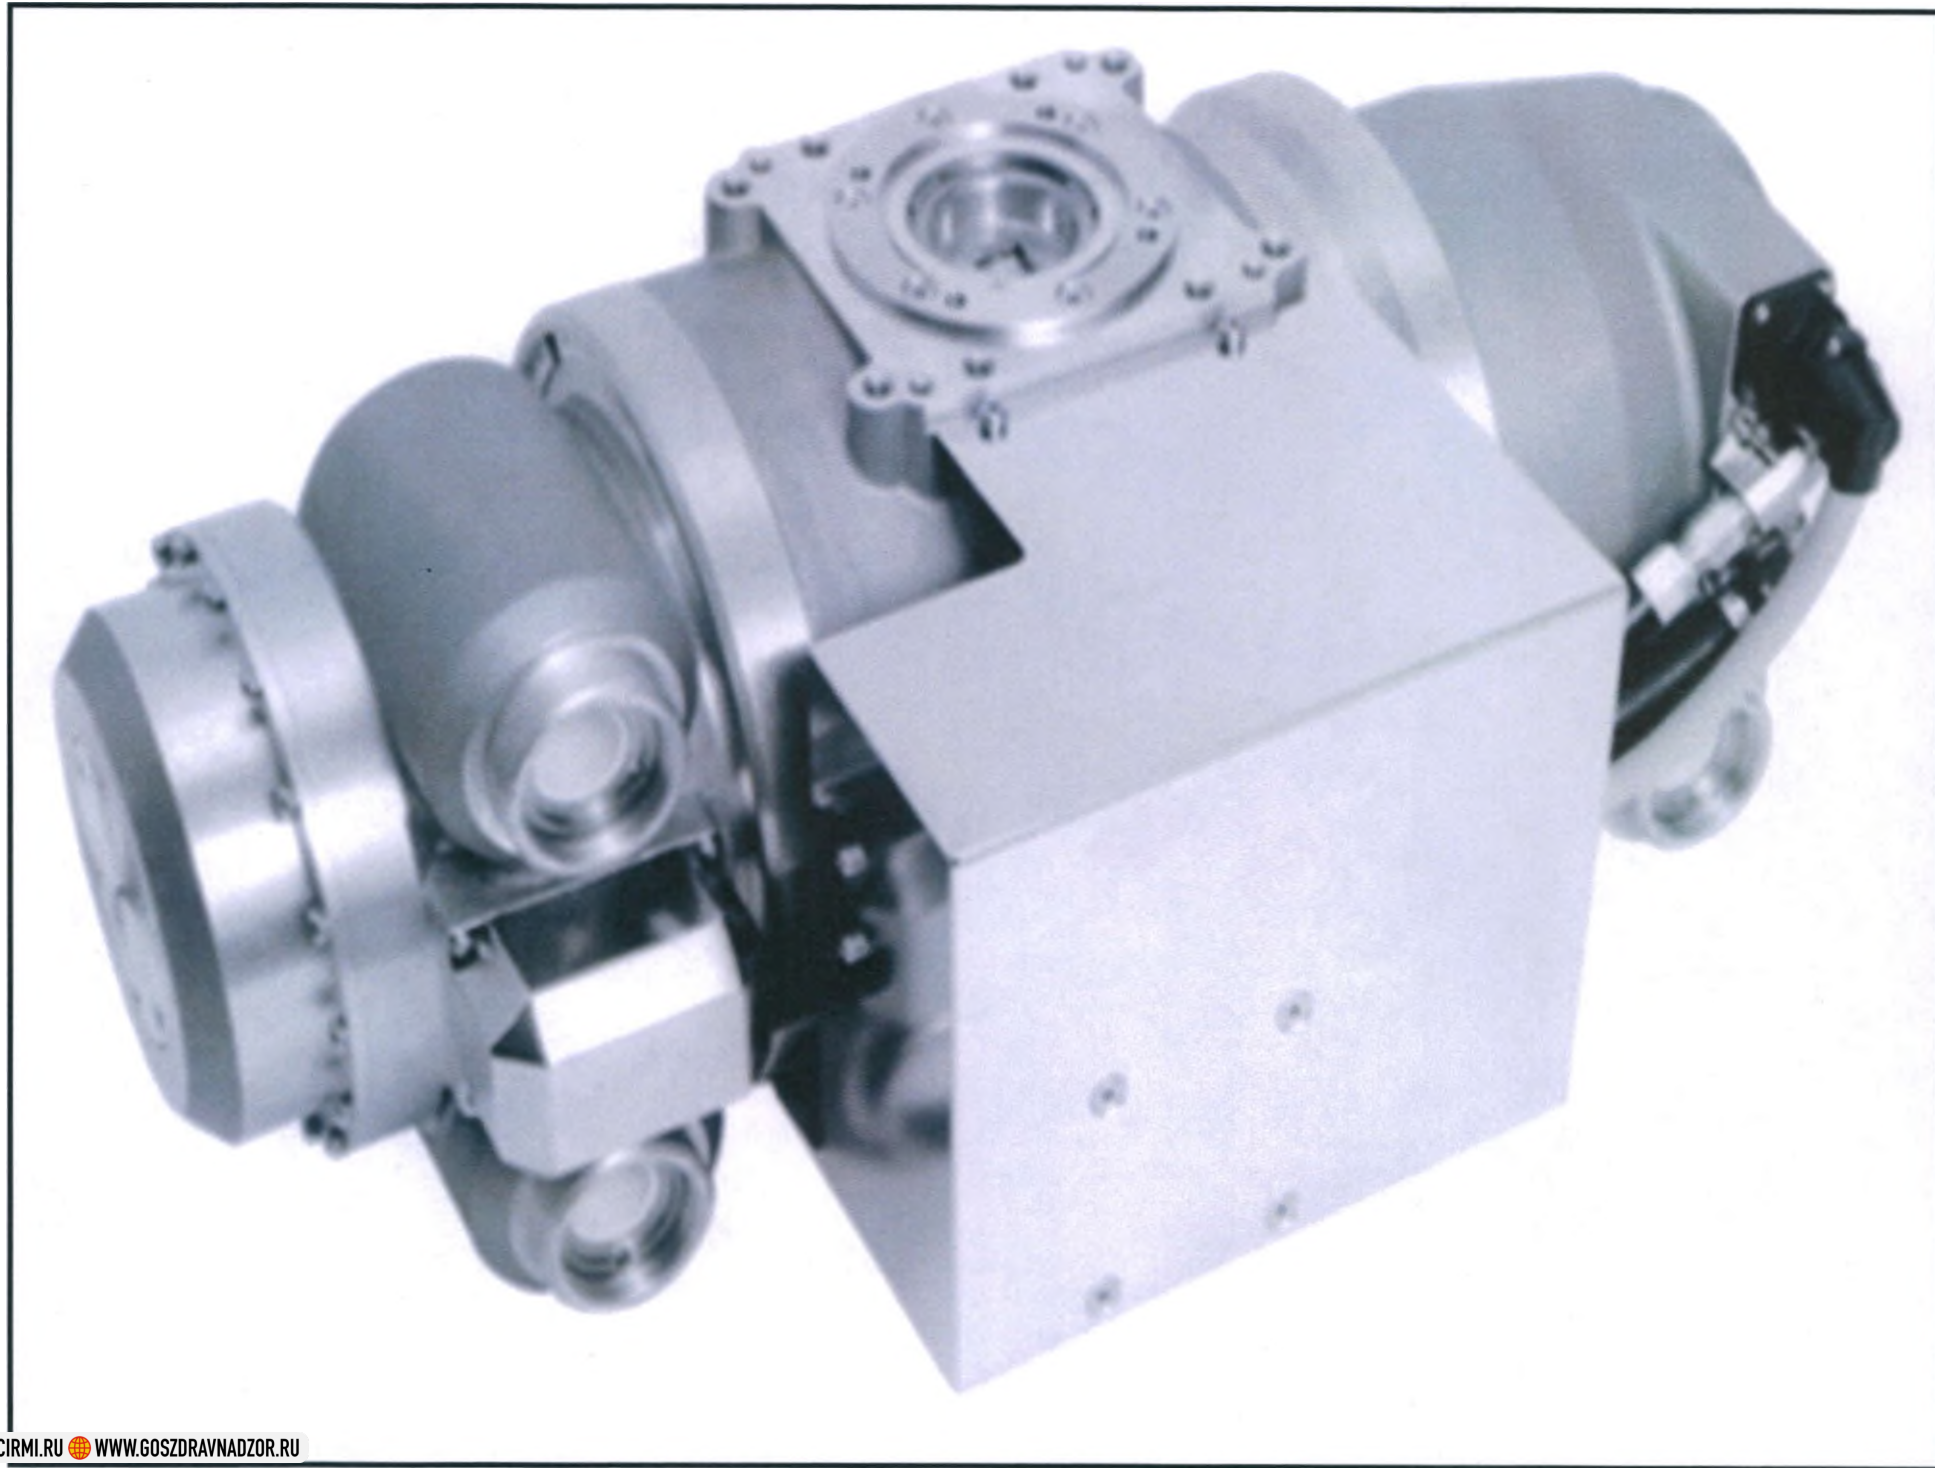

4. Скоростное пусковое устройство с вращающимся анодом (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).

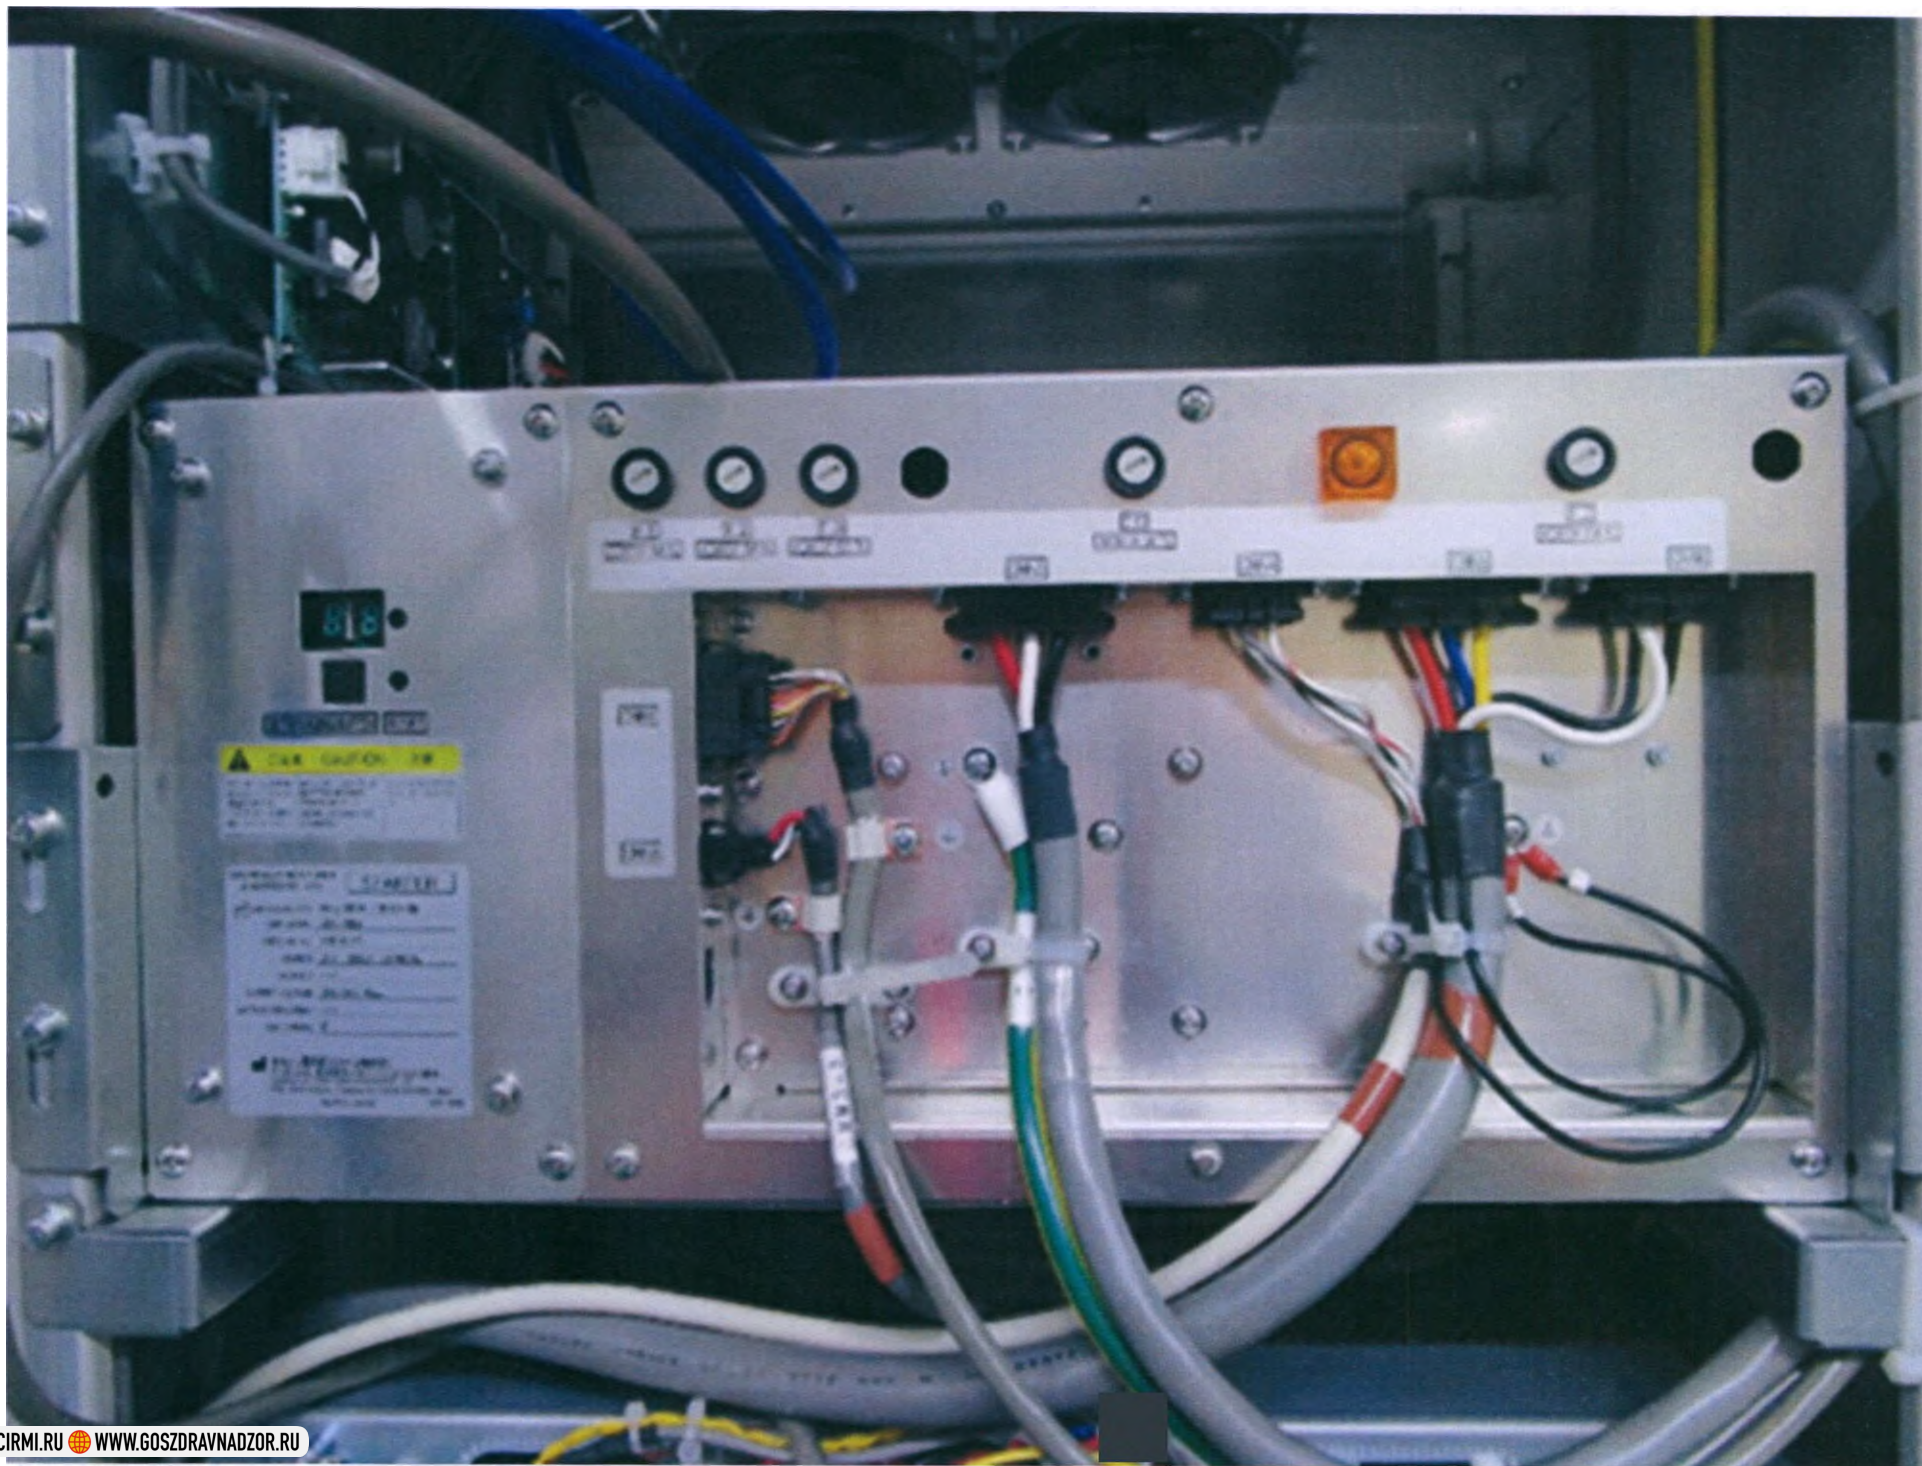


5. Комплект кабелей для рентгеновской трубки.

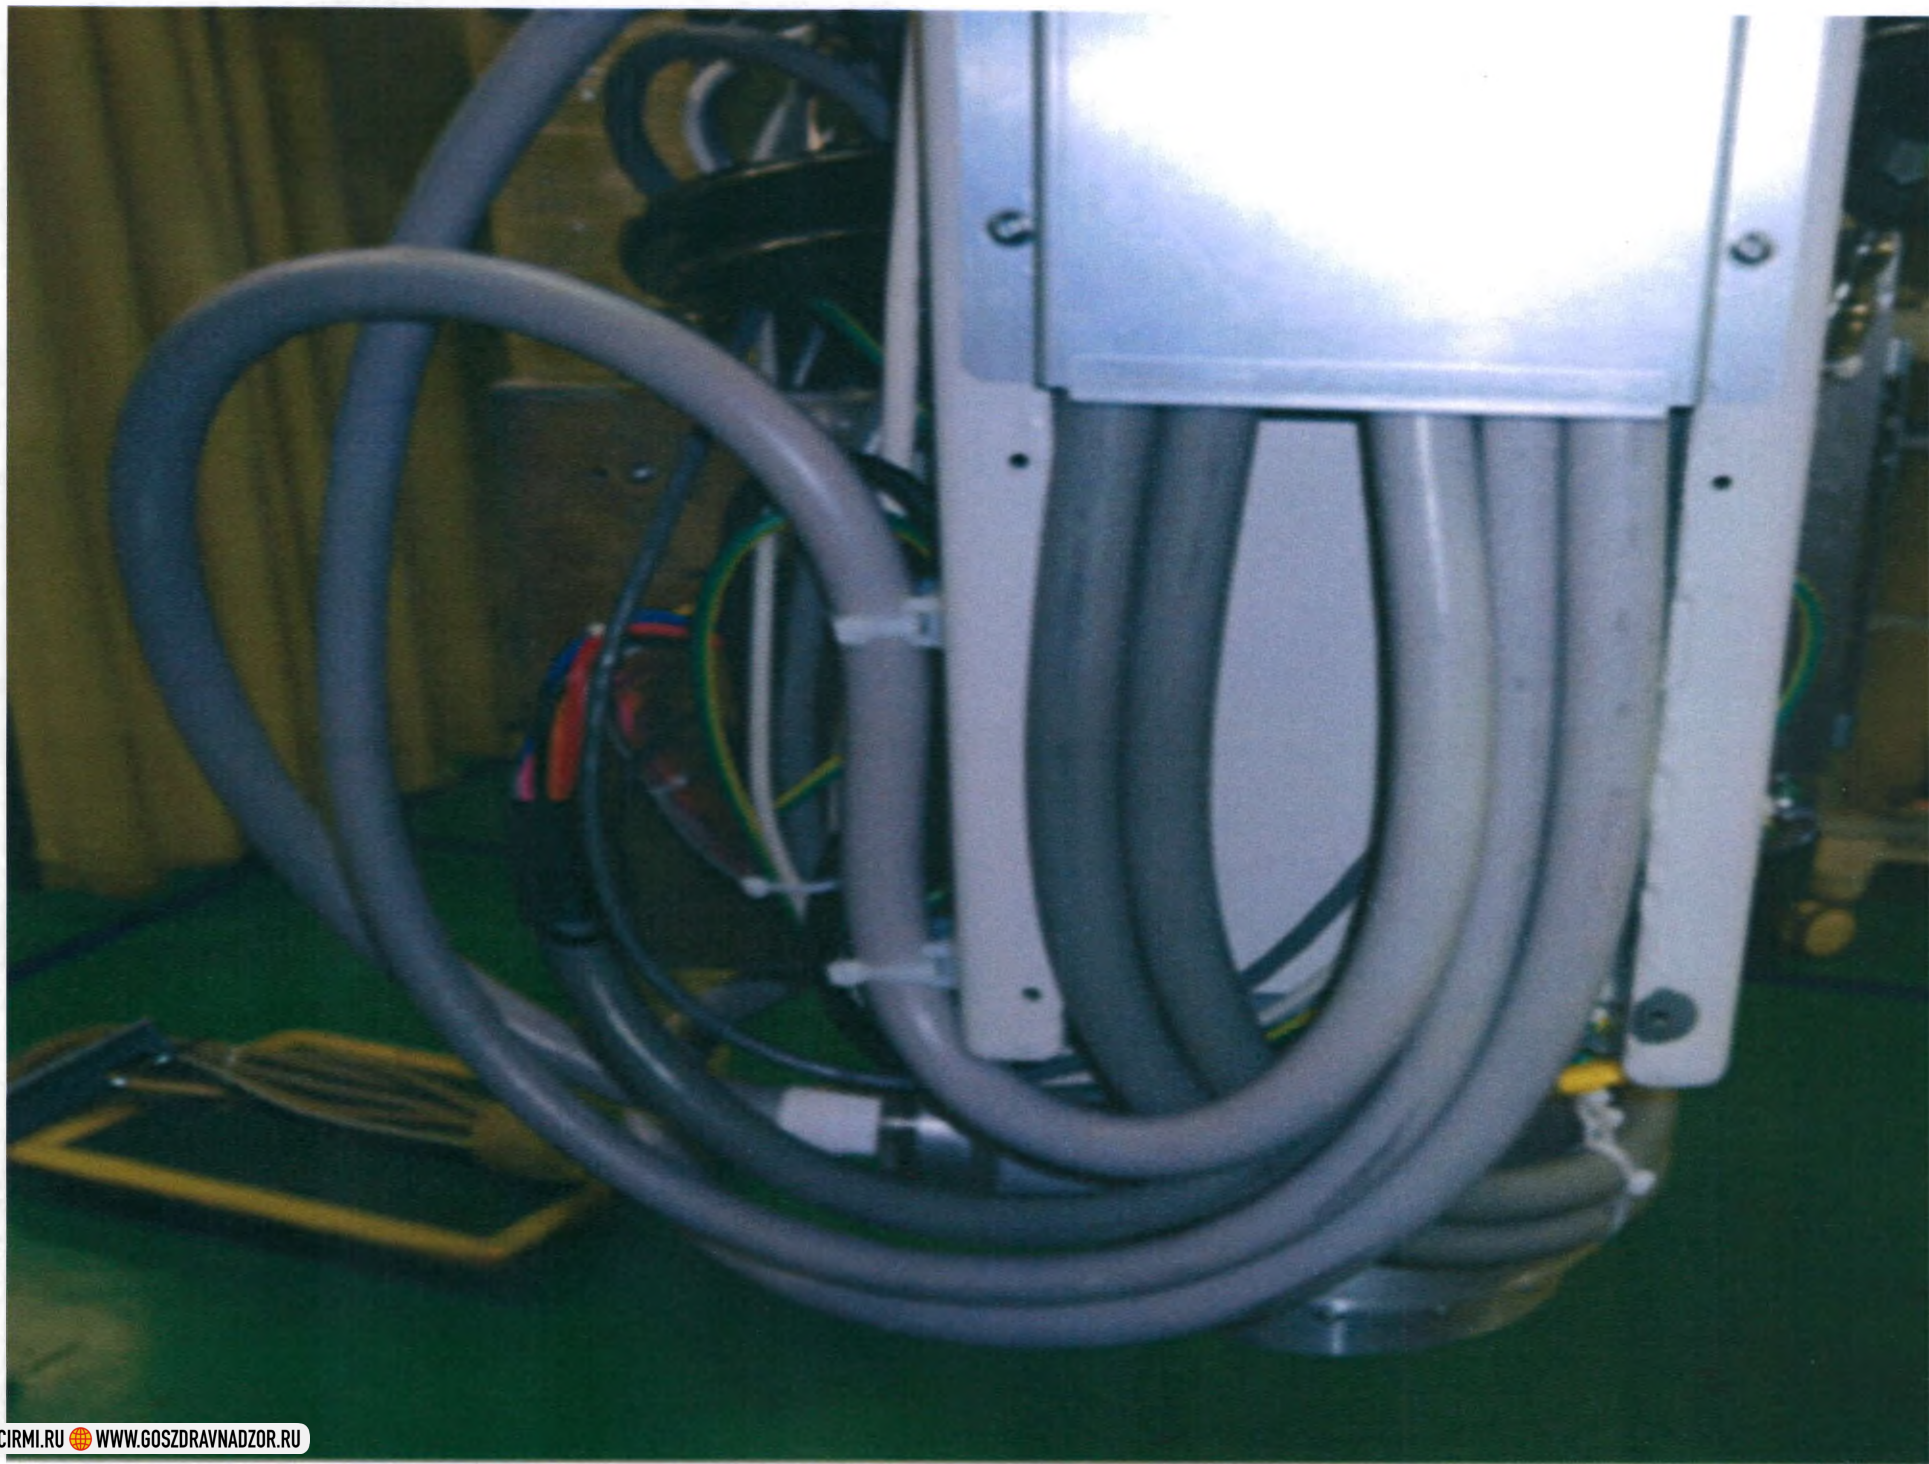

6. Теплообменник с водяным охлаждением (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).



7. Шланг теплообменника - 2 шт.

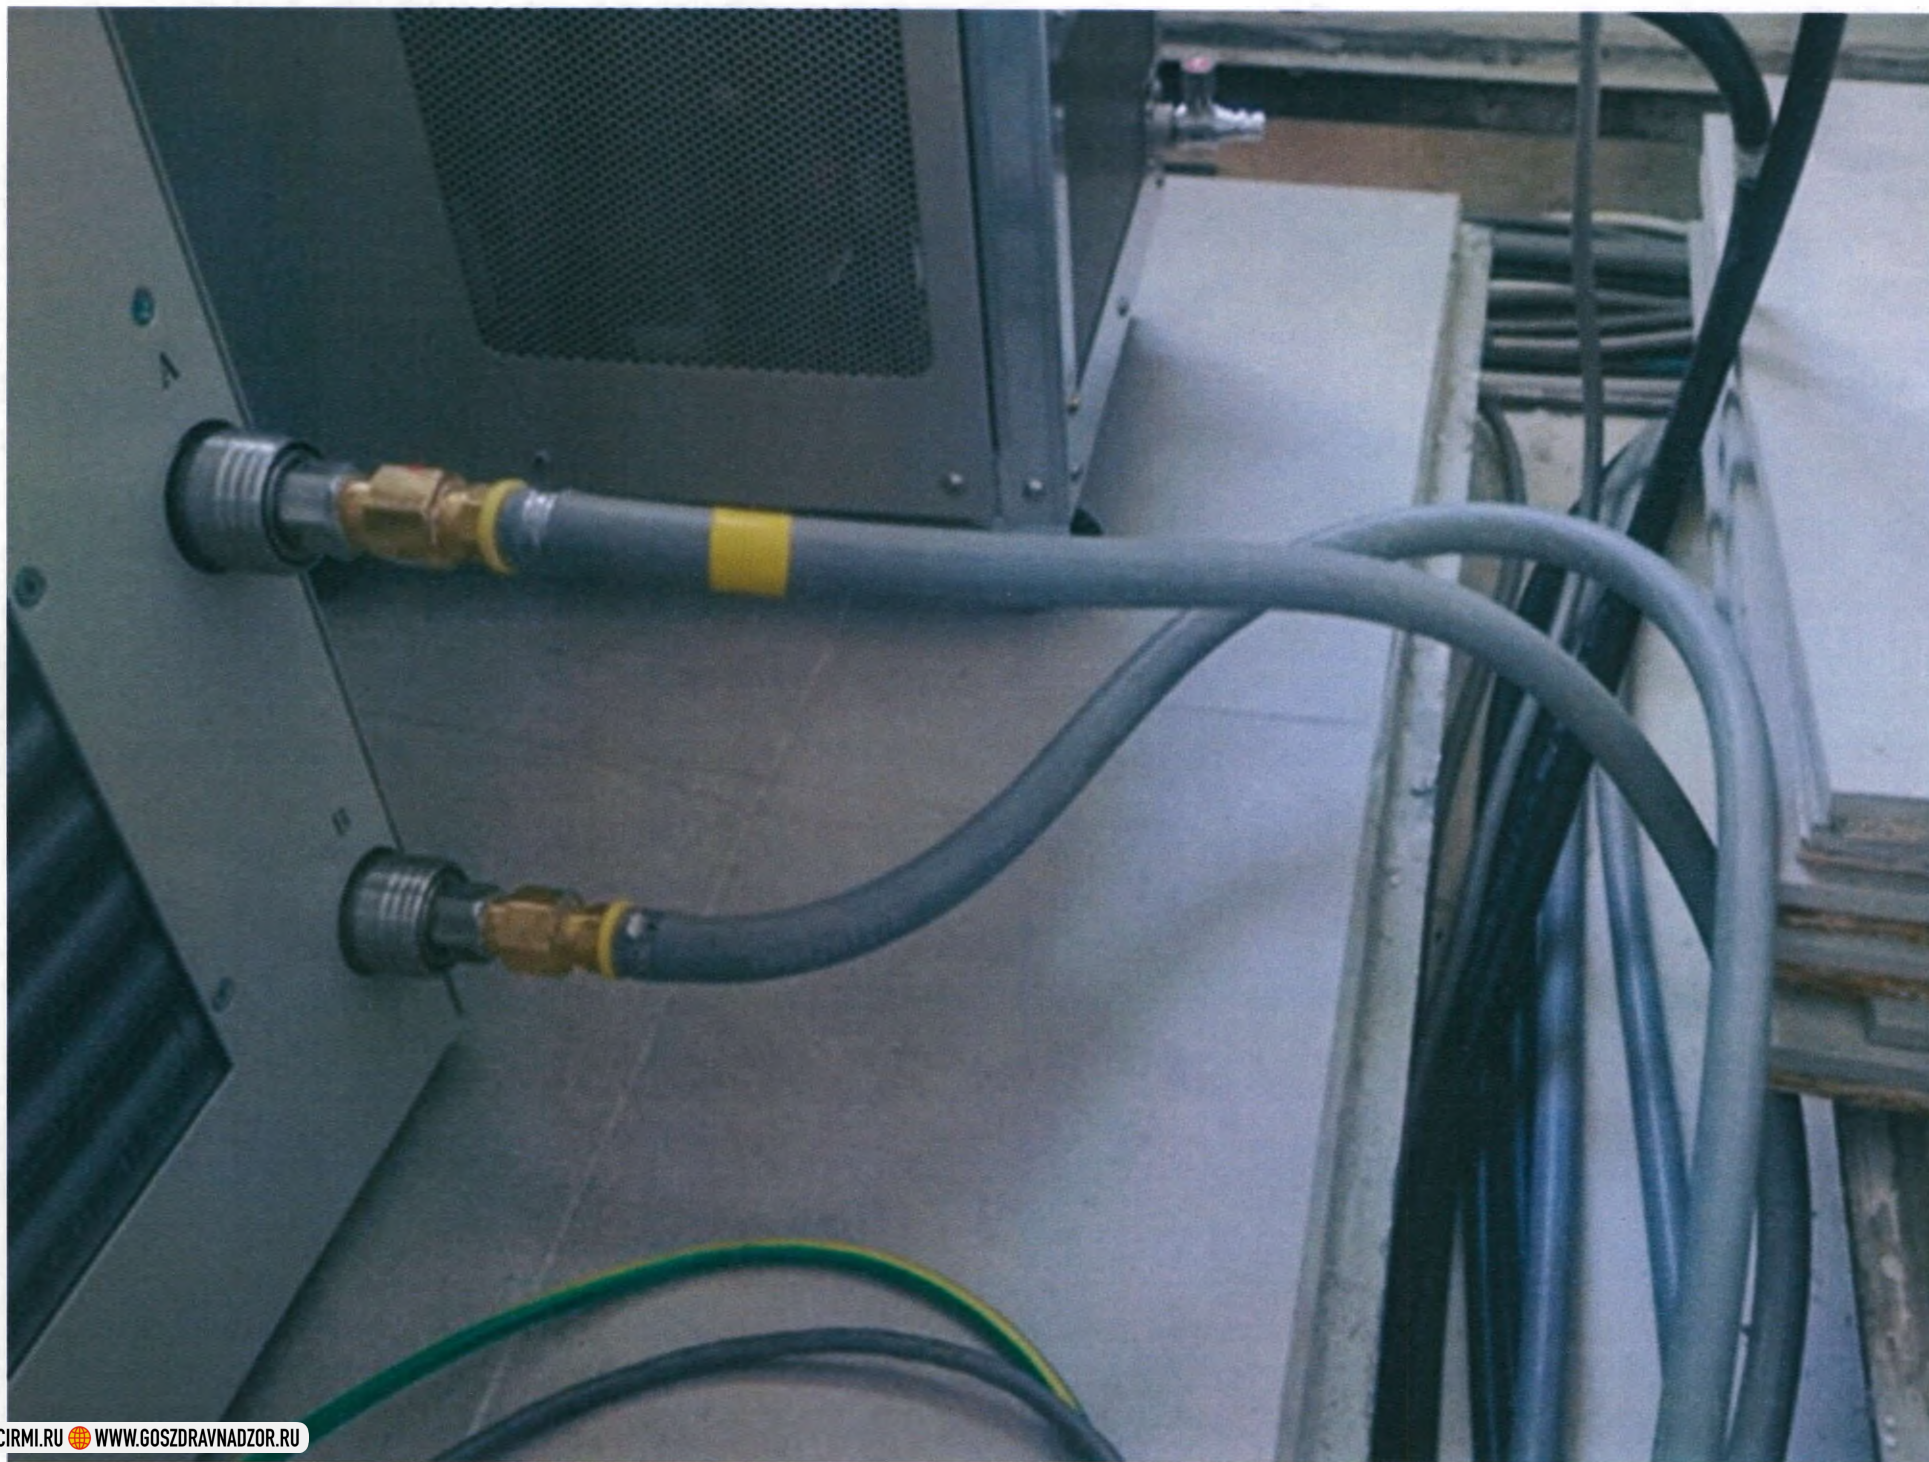





Блок водяного охлаждения




Основной блок 8-дюймового FPD




Командный процессор




11. Комплект интерфейса механизма наклона стола CAS-880A.

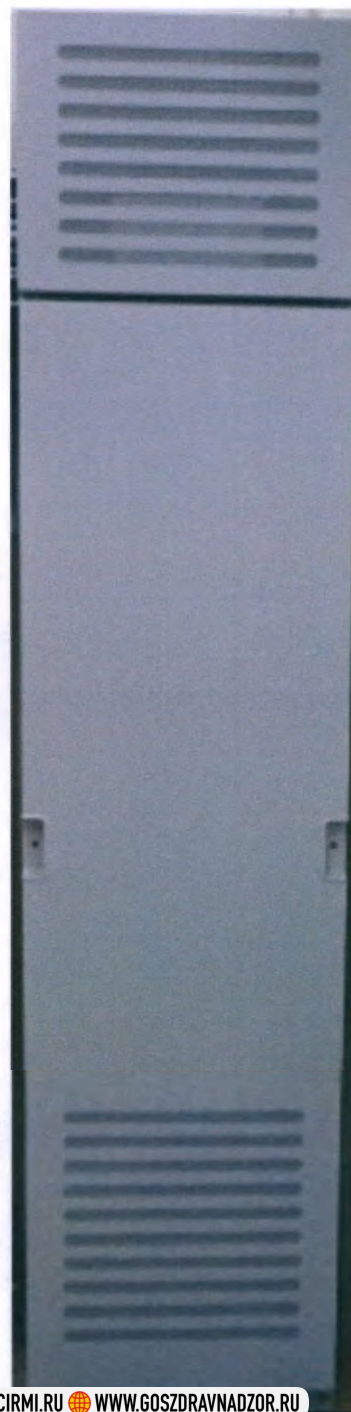


Установлены внутри
шкафа управления
CAS-880A

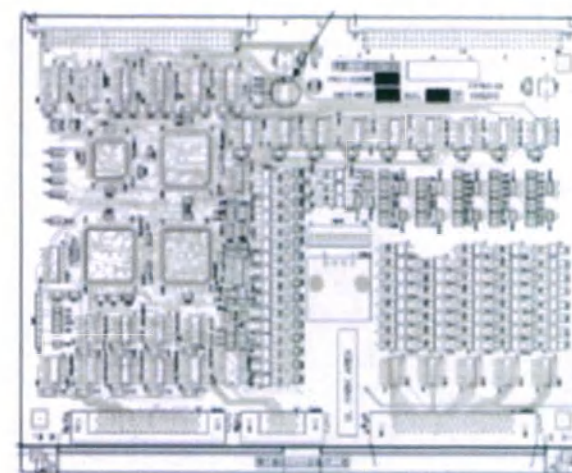

Электронная плата Hyper IO pcb

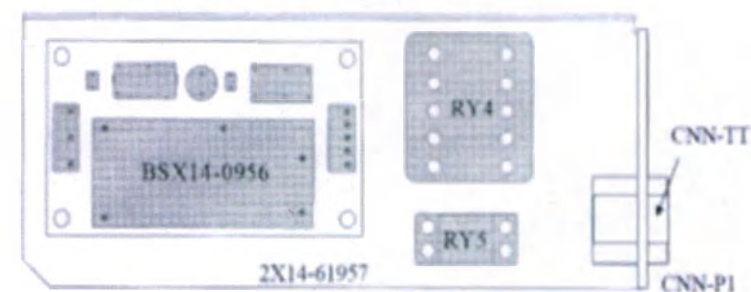


Интерфейсный блок

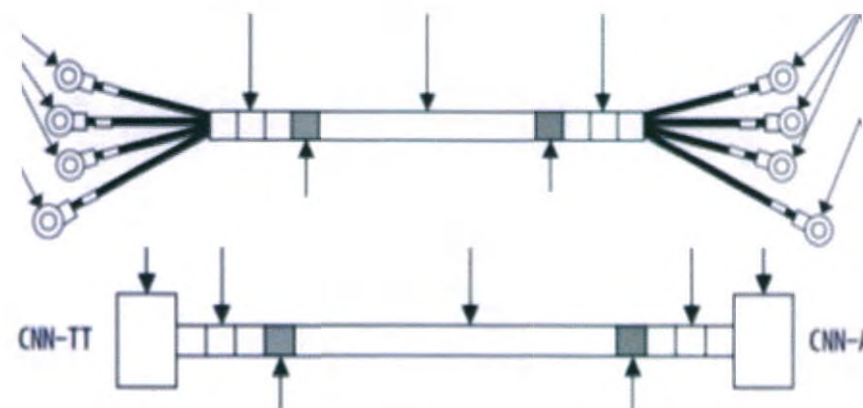


Интерфейсные кабели

12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: - основная часть стола для катетеризации;

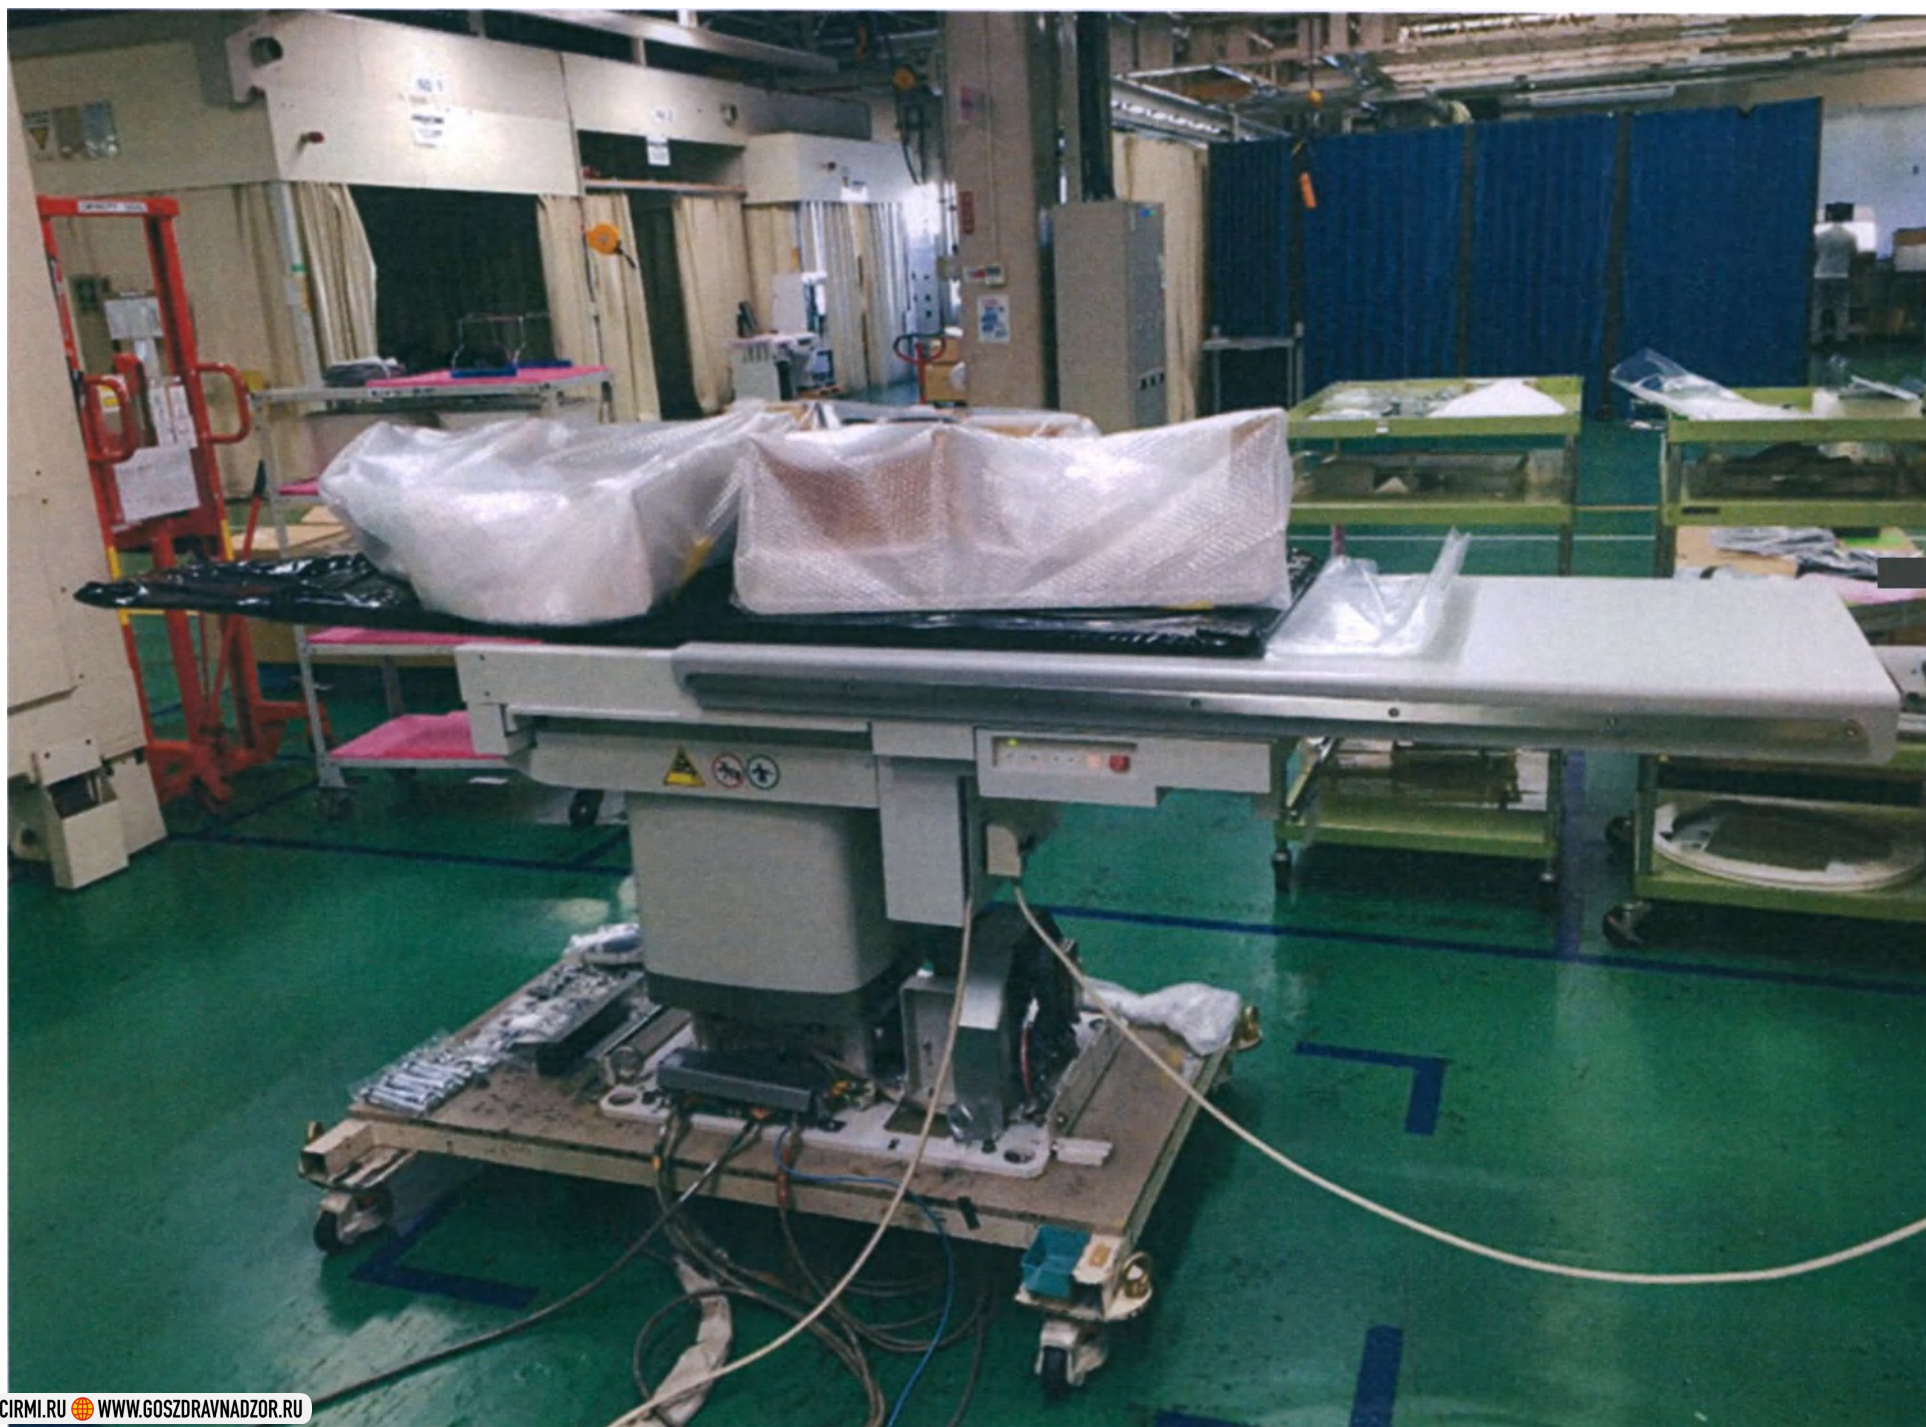

12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: - стандартная накладка для деки стола;

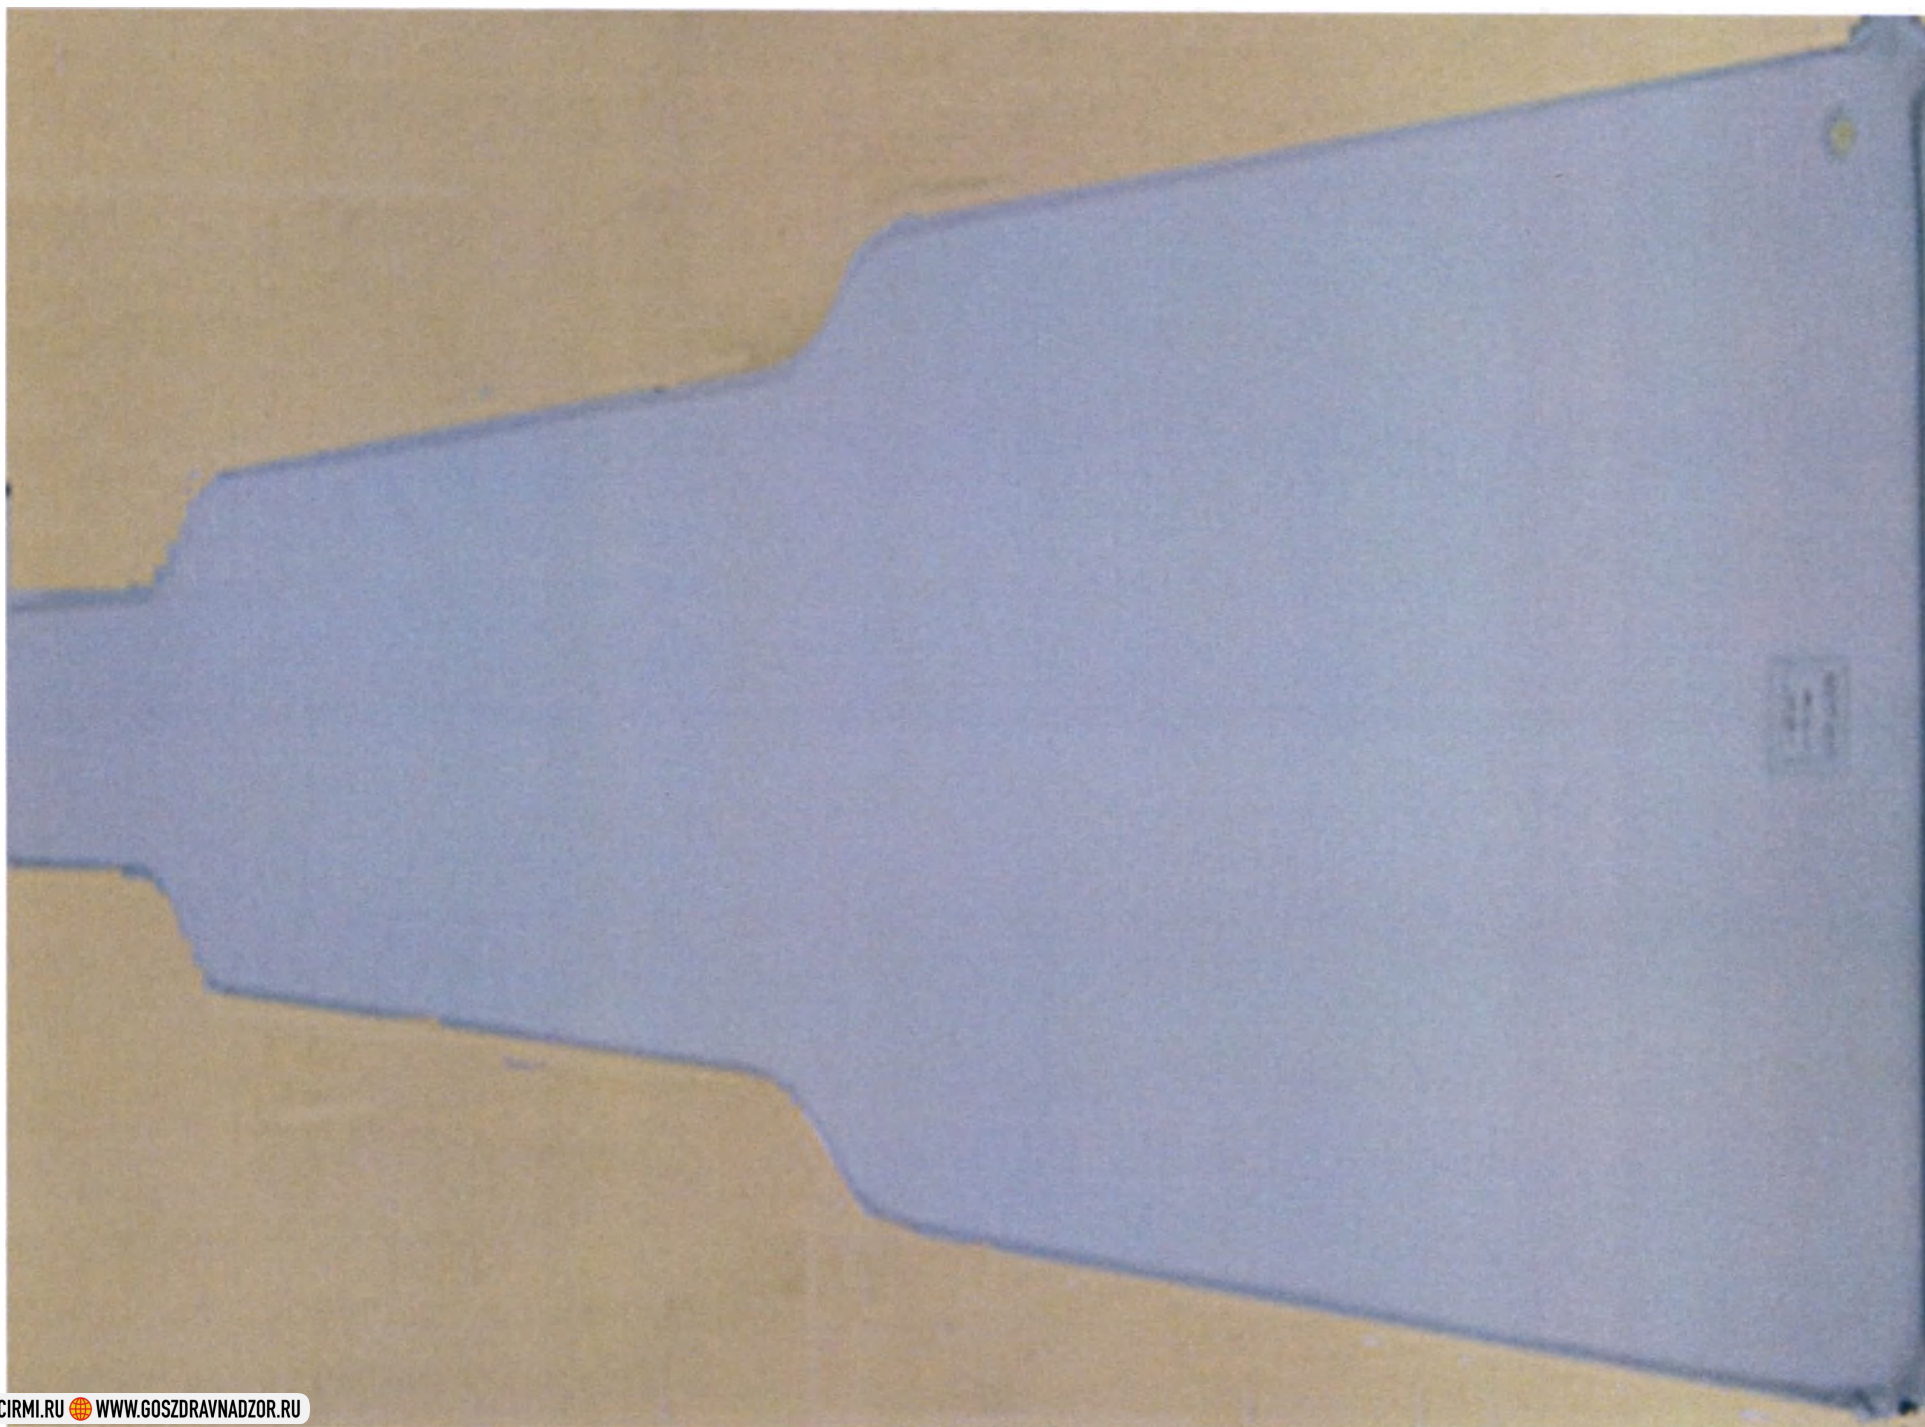


12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель CAT-850B, в составе: - стойка для капельной инфузии;






12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: - подлокотник.

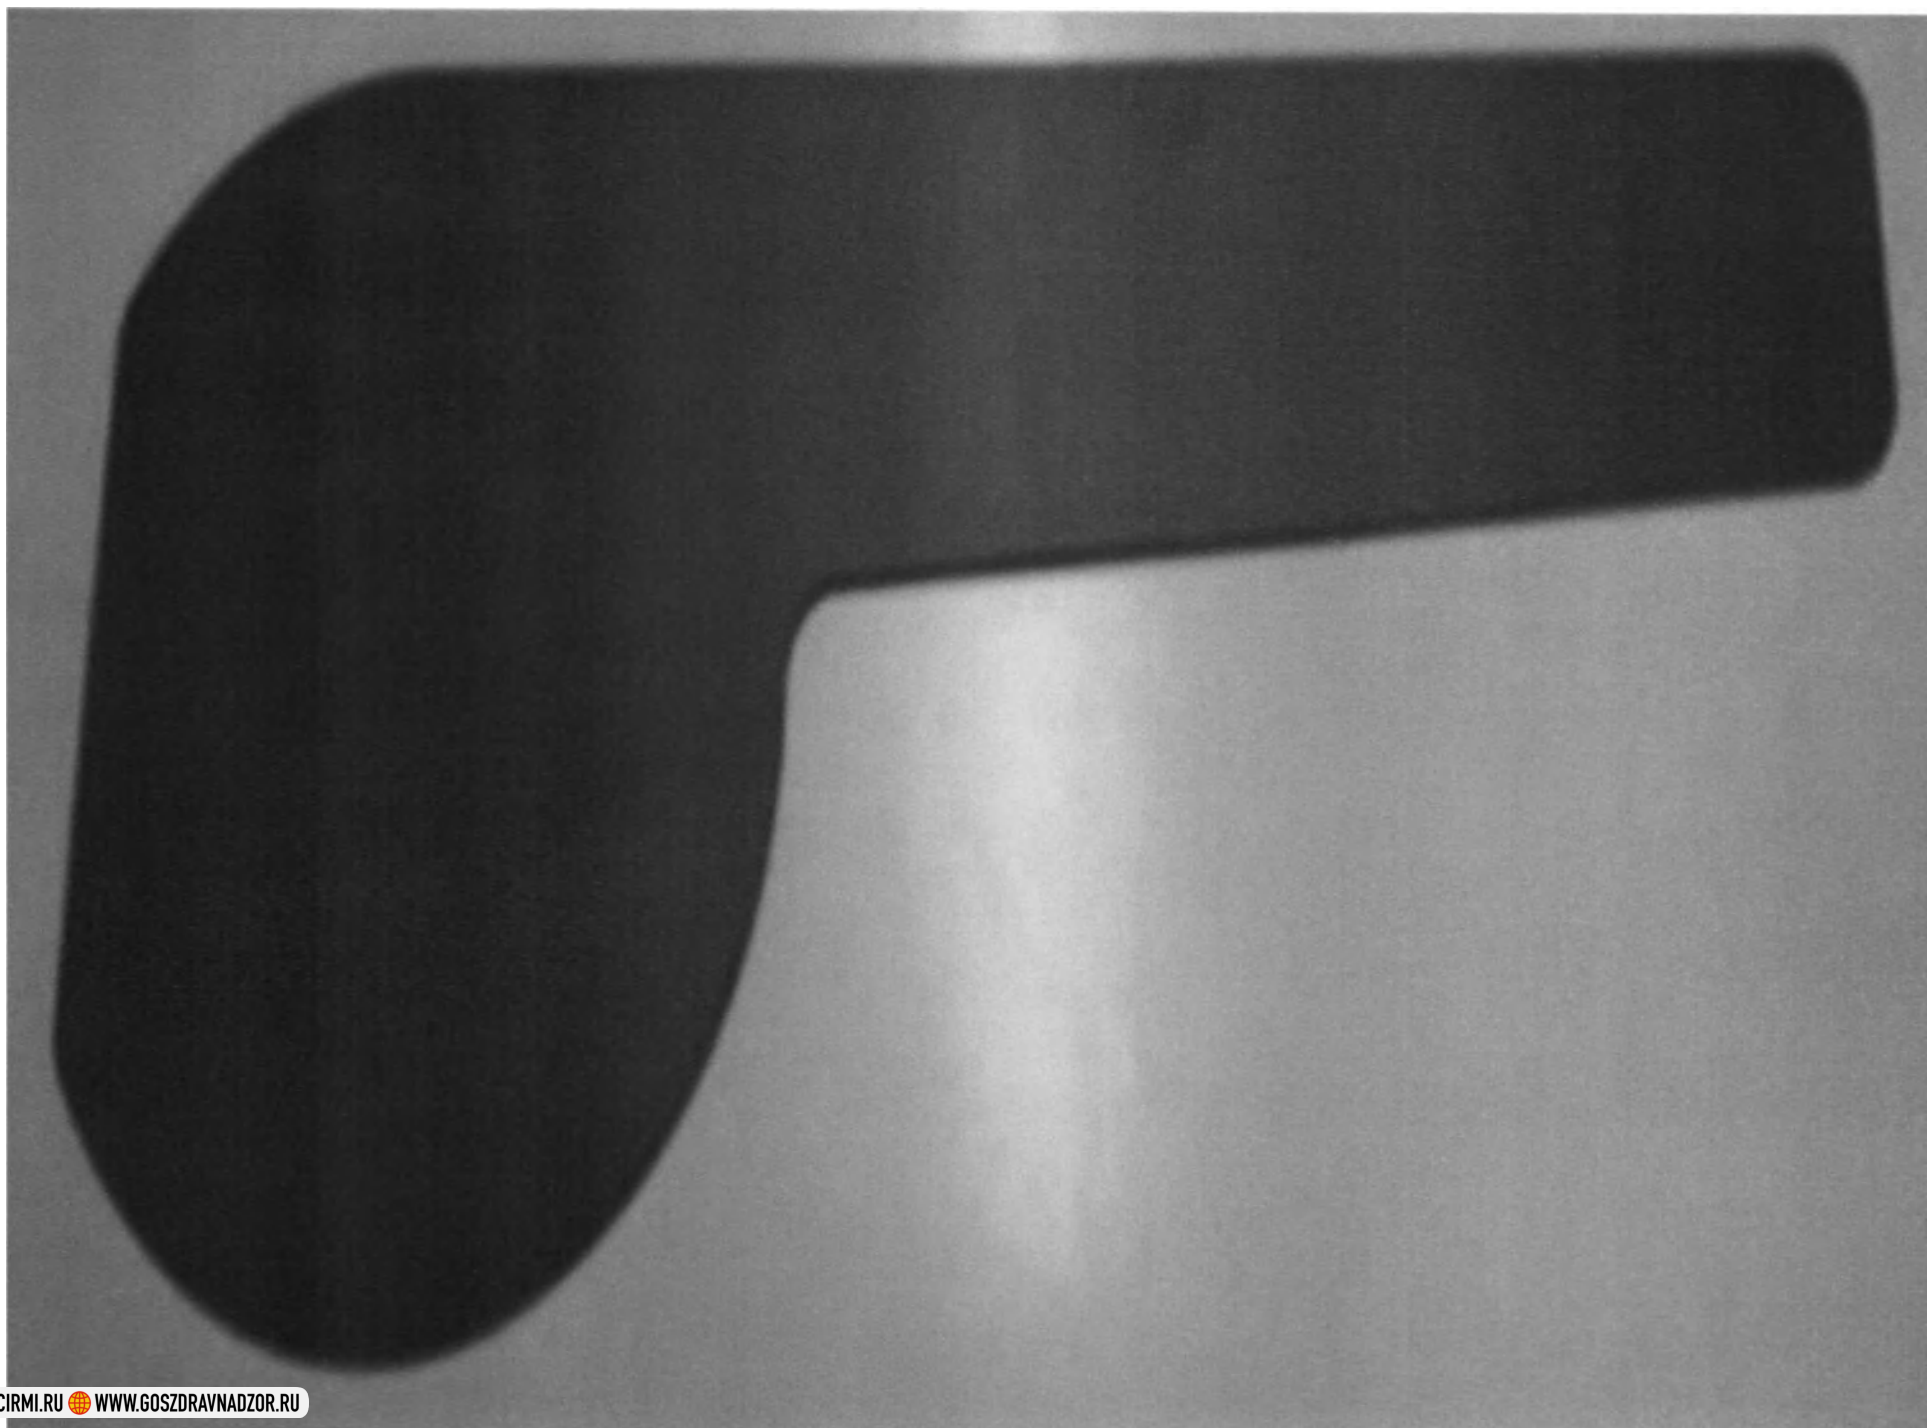

12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - основная часть стола для катетеризации;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - пульт управления столом;

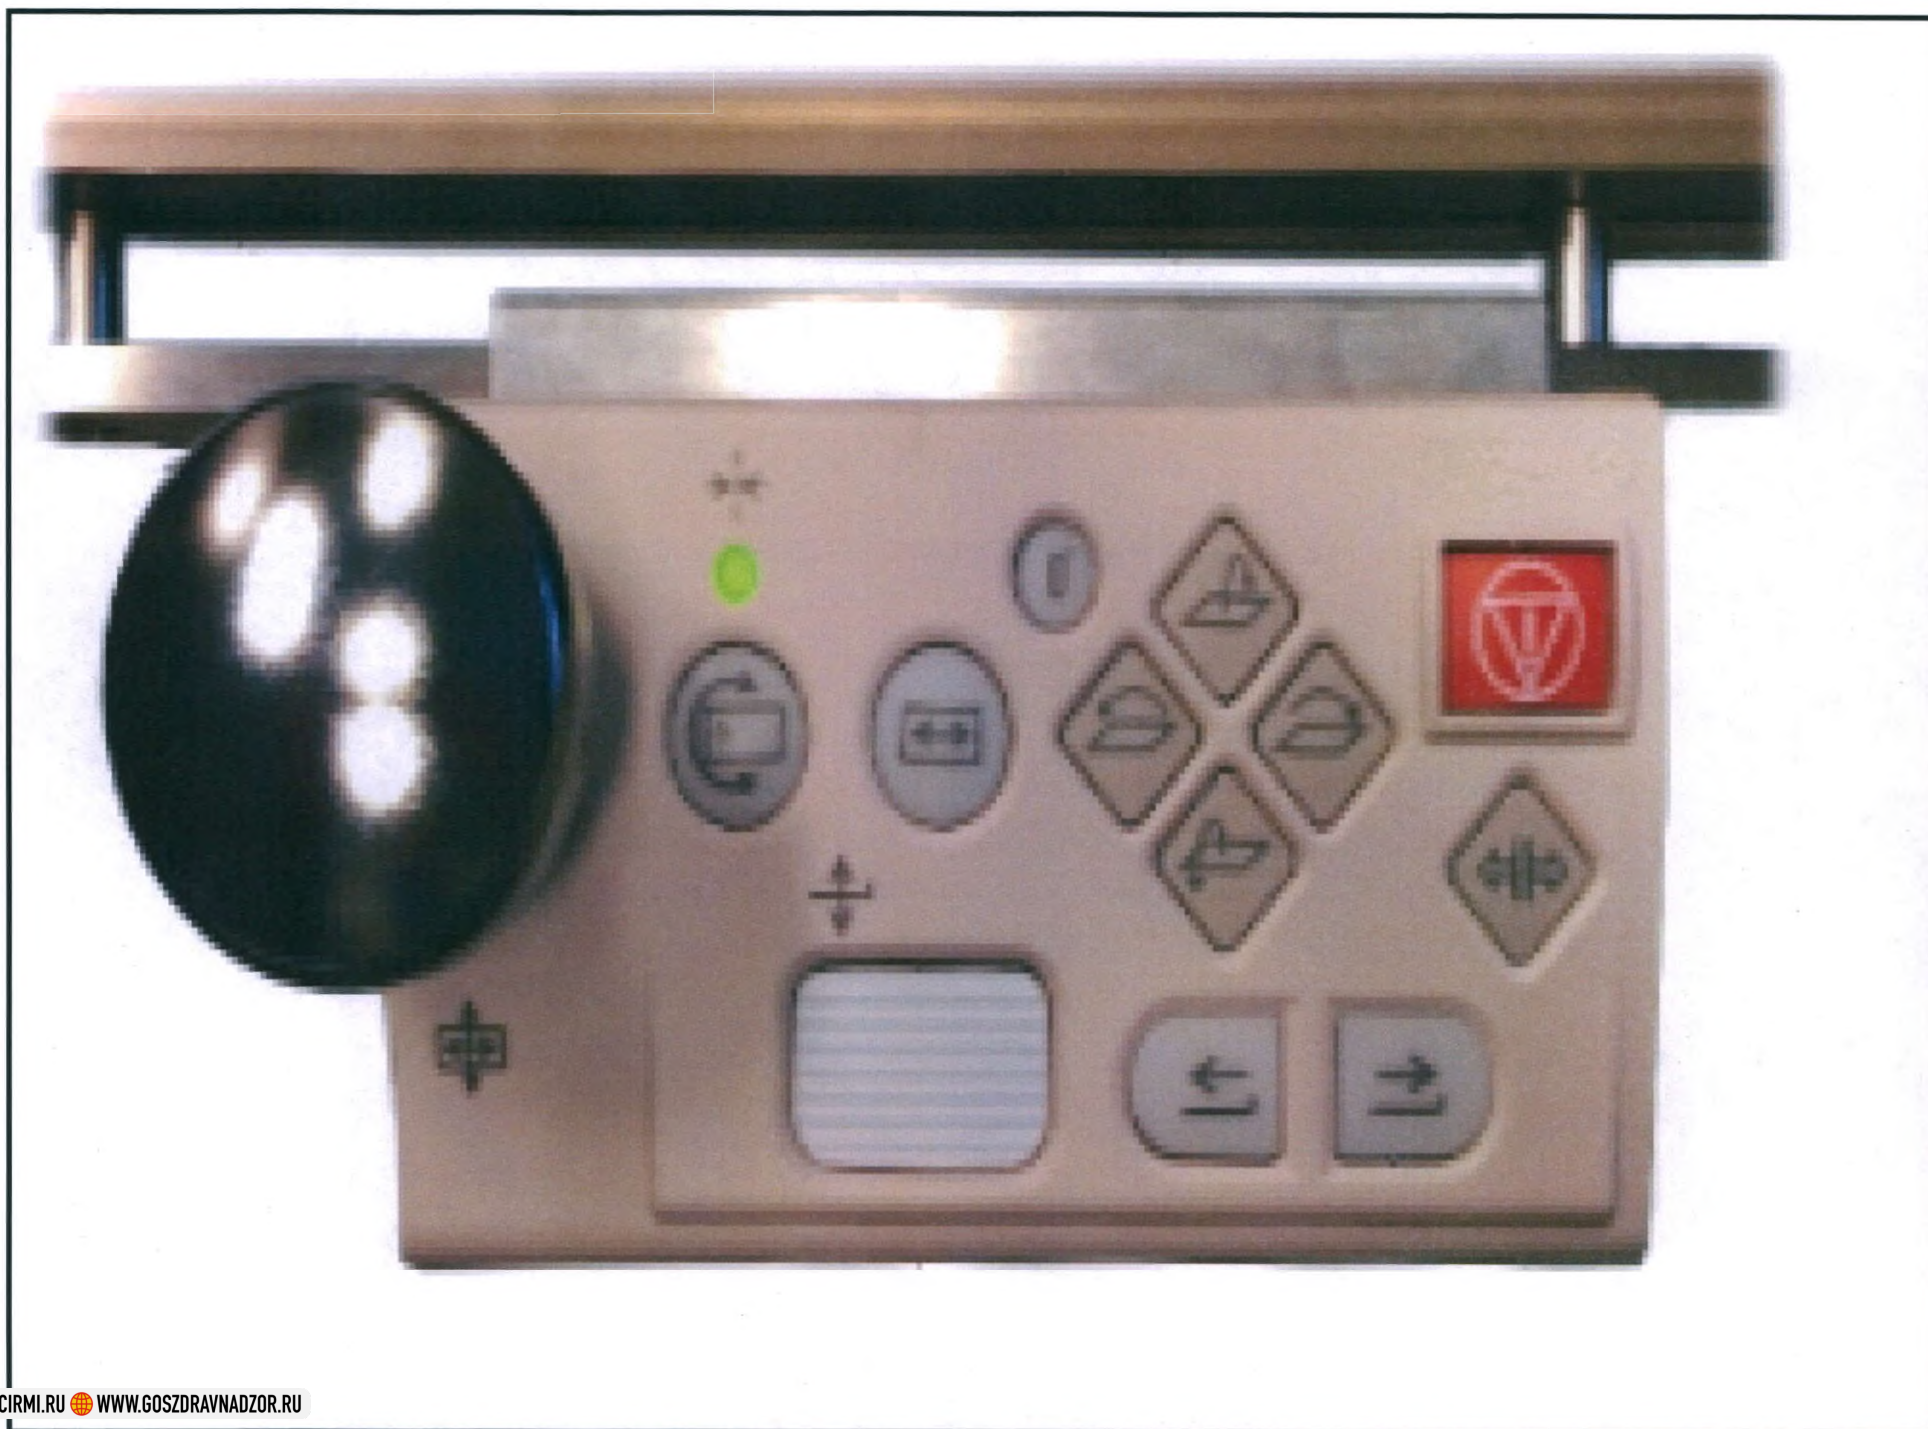

12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - стойка для капельной инфузии;





12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - ремень для иммобилизации пациента - не более 2-х штук.




13. Ножной переключатель (в кабинете сканирования).




14. Цифровая рентгенографическая система.

20

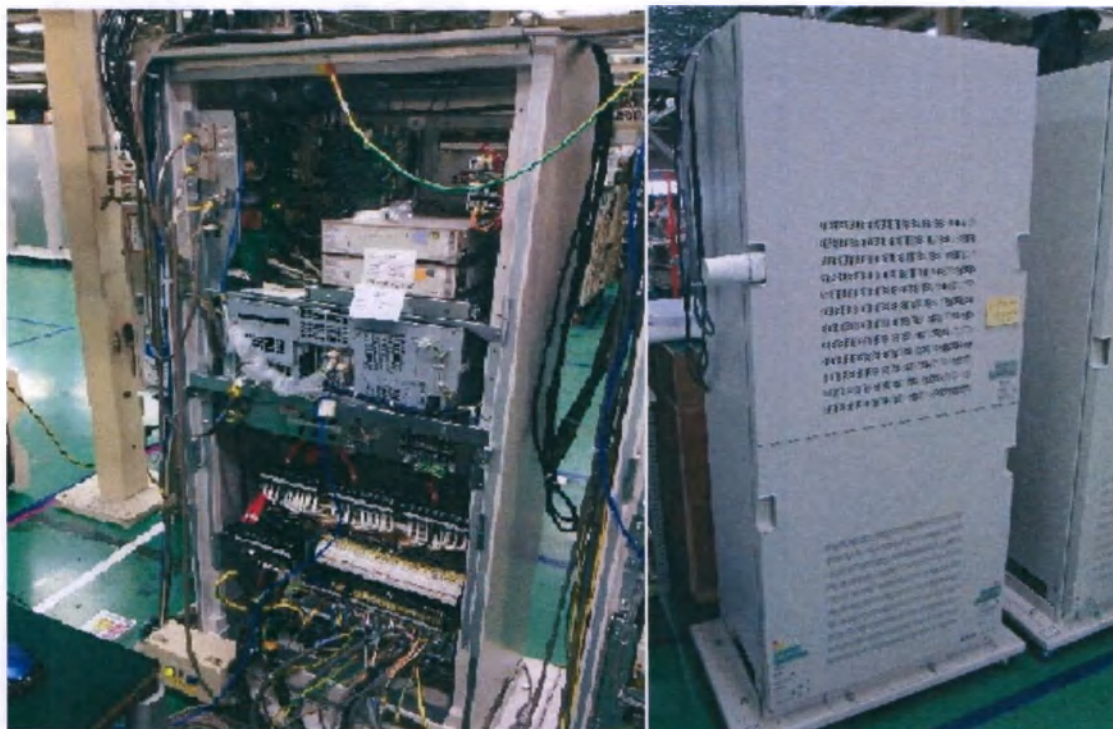


Системный шкаф

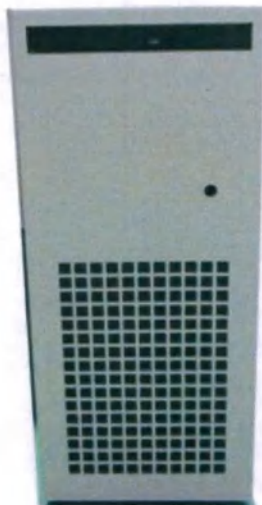

Компьютер




Блок управления

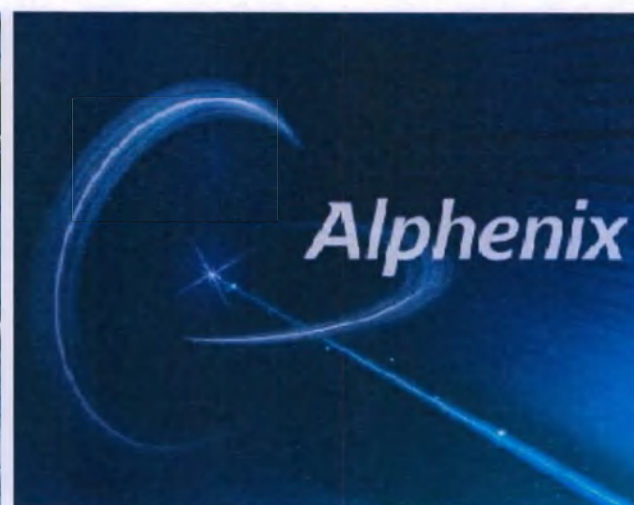

Программное обеспечение
основное

консоли системы

15. Консоль системы, в составе: - комплект клавиатуры;

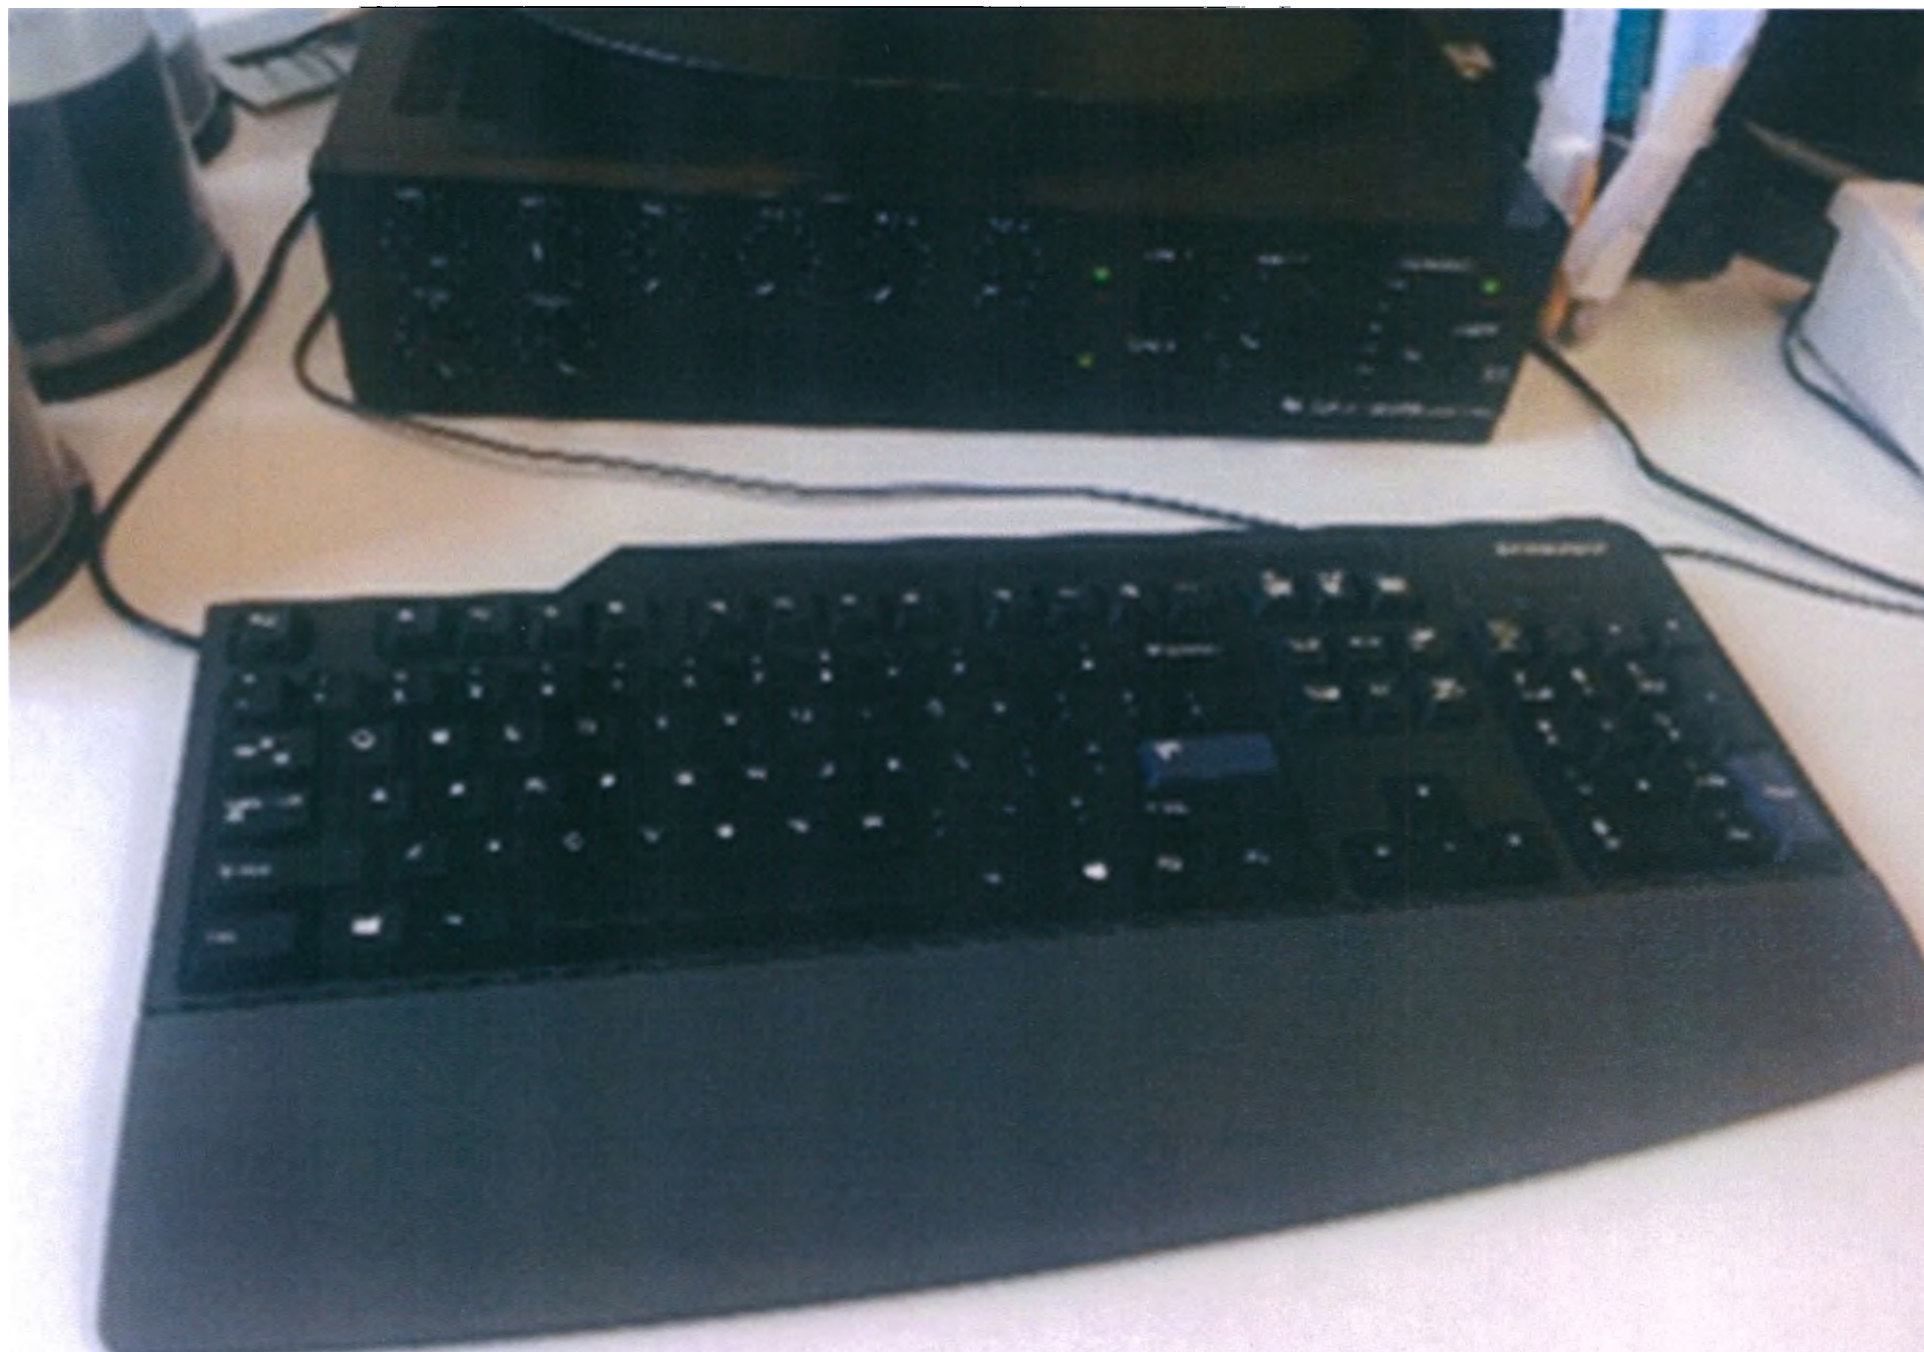

15. Консоль системы, в составе: - комплект клавиатуры;

21



15. Консоль системы, в составе: - монитор системы; - блок включения электропитания.




16. Ножной переключатель для рентгеноскопии в кабинете управления.









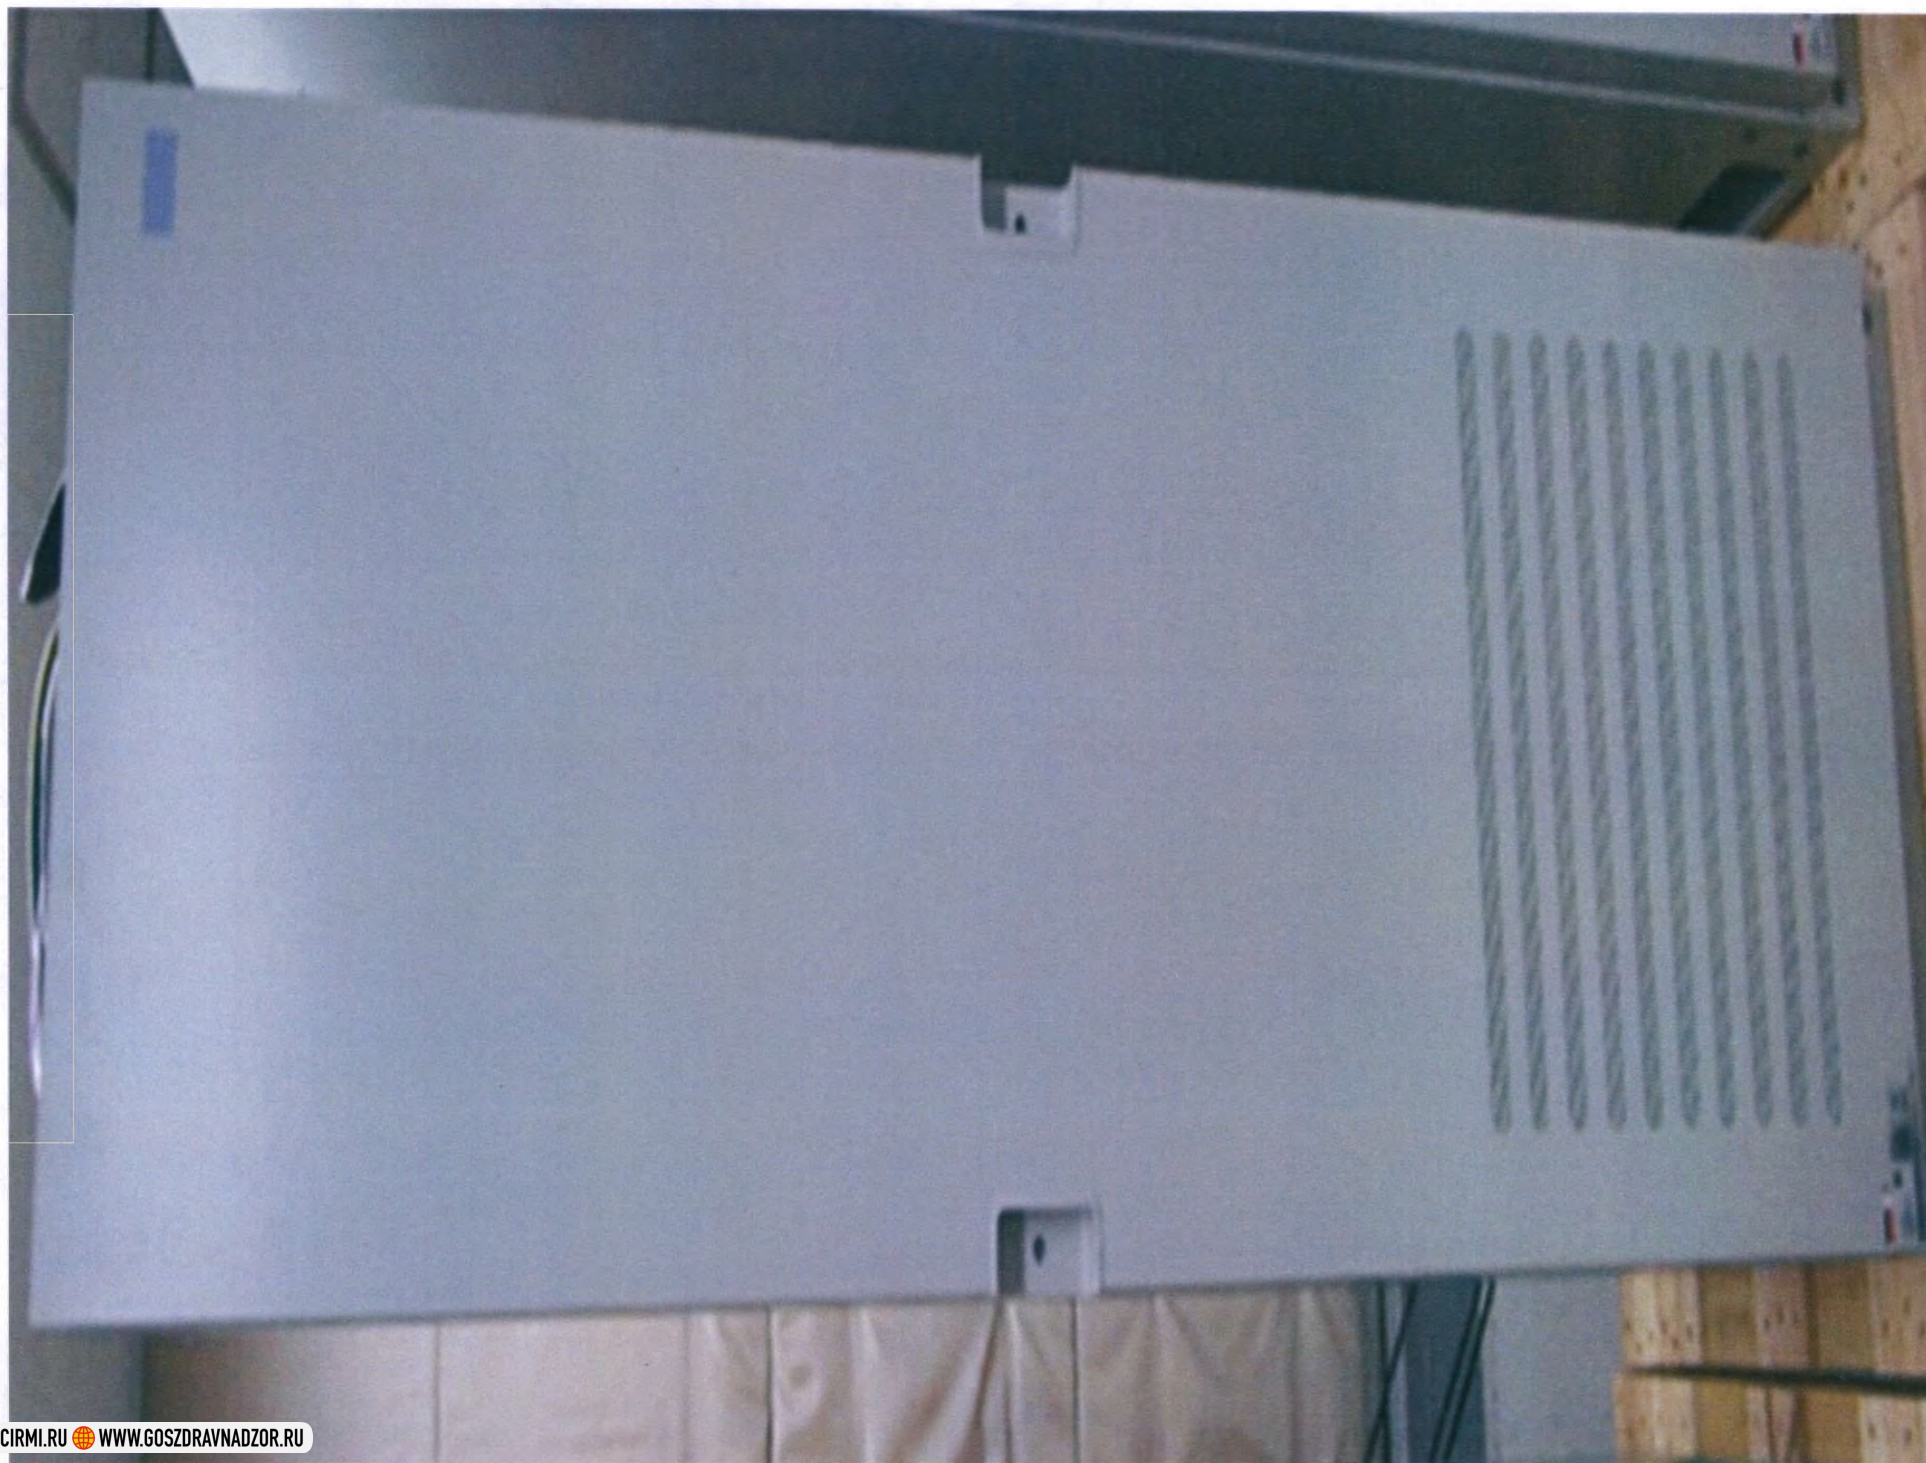


20. Подвесное устройство для мониторов.

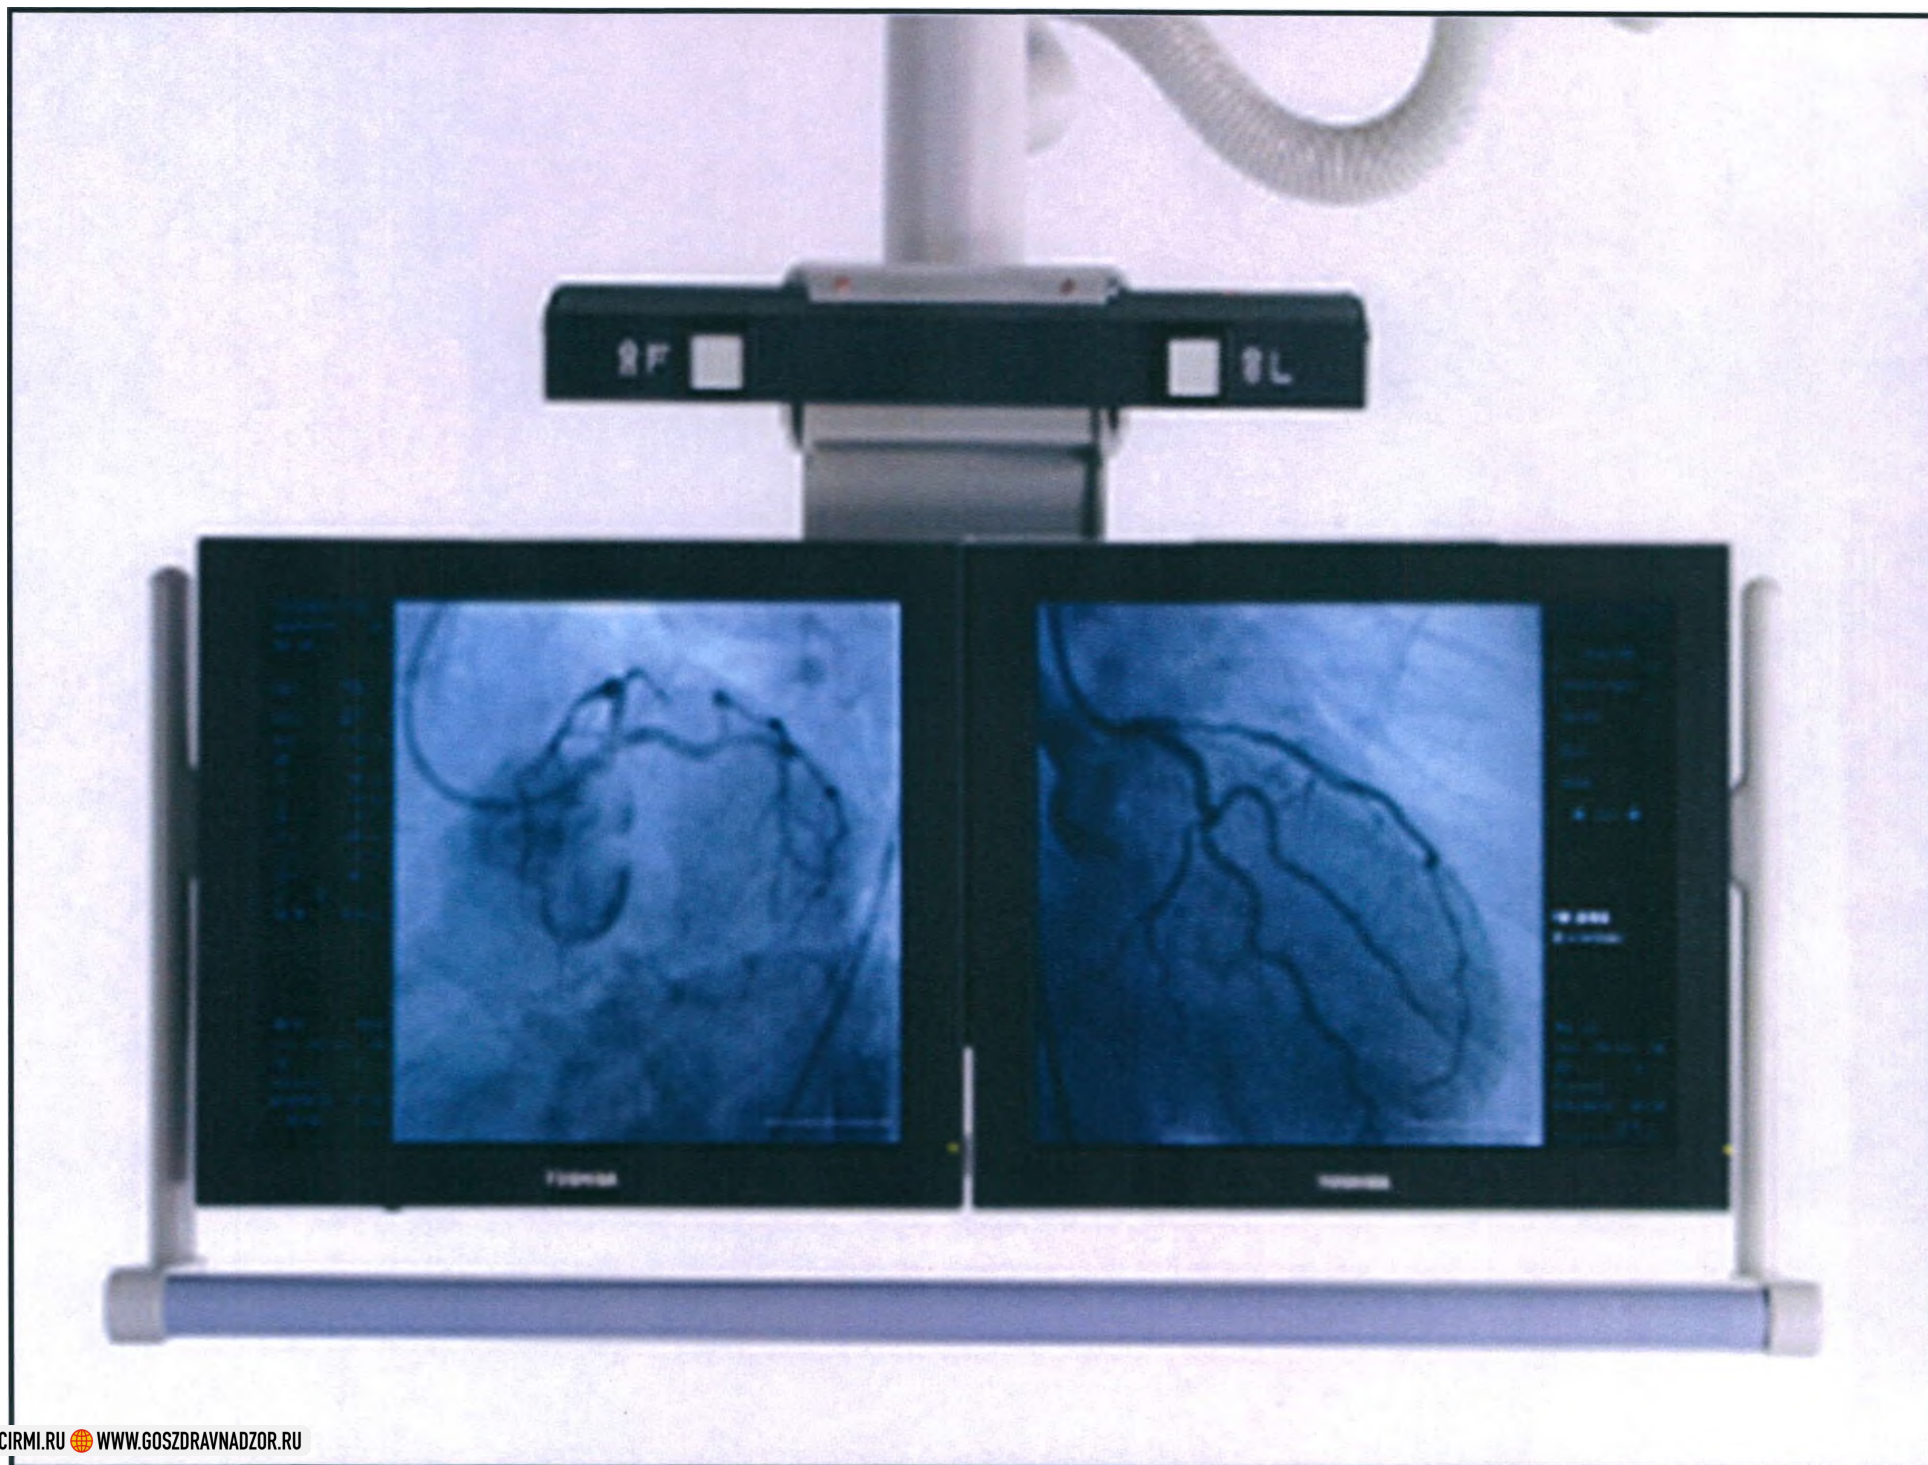


20. Подвесное устройство для мониторов.

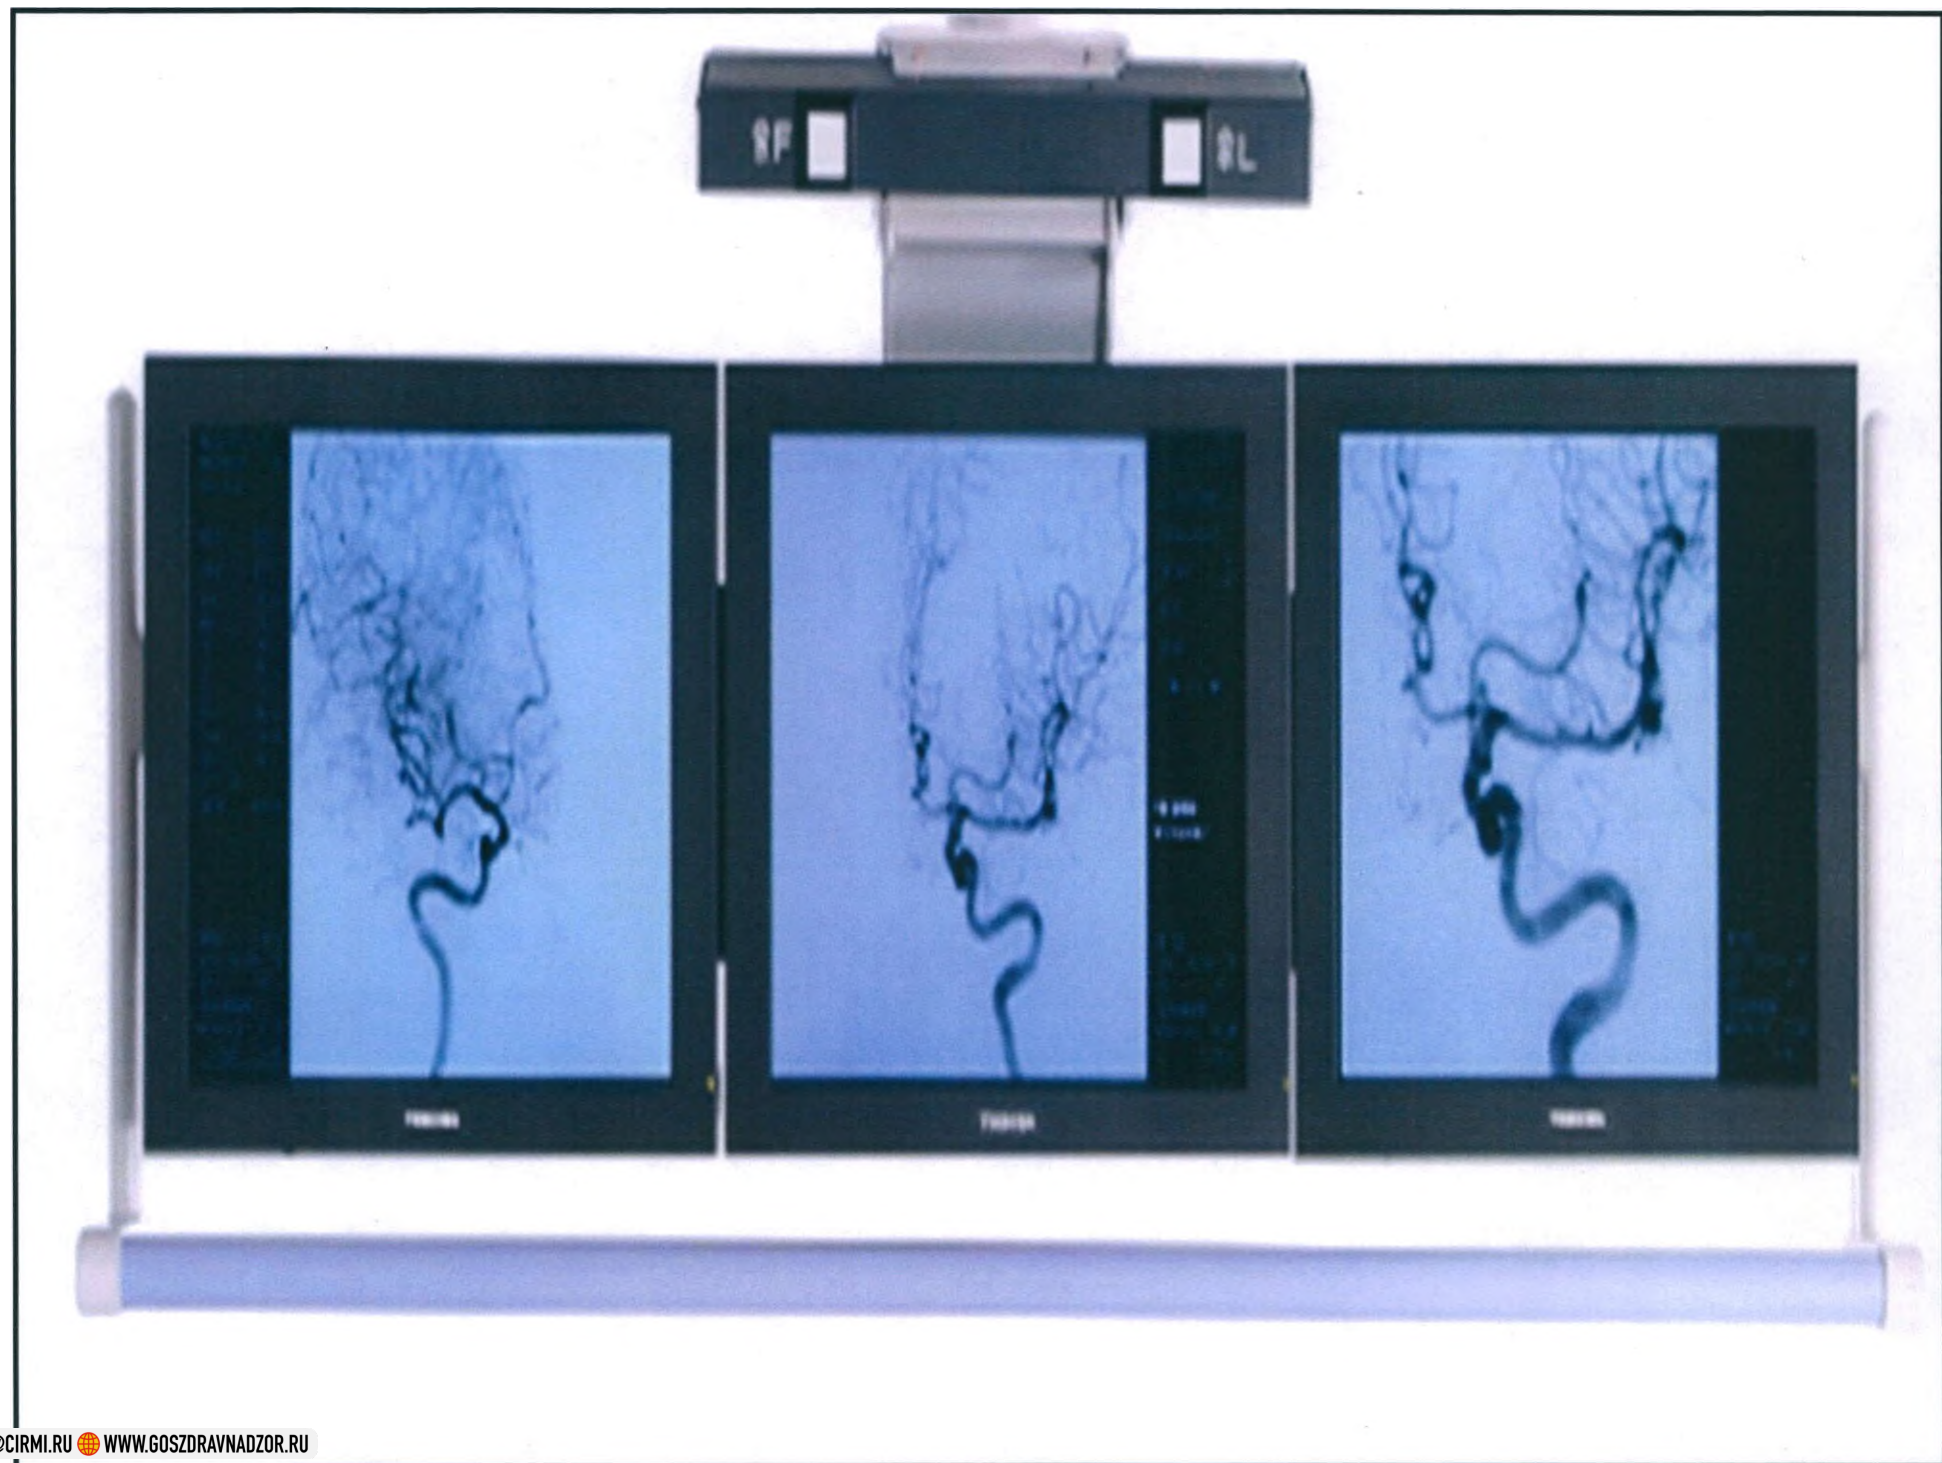


20. Подвесное устройство для мониторов.

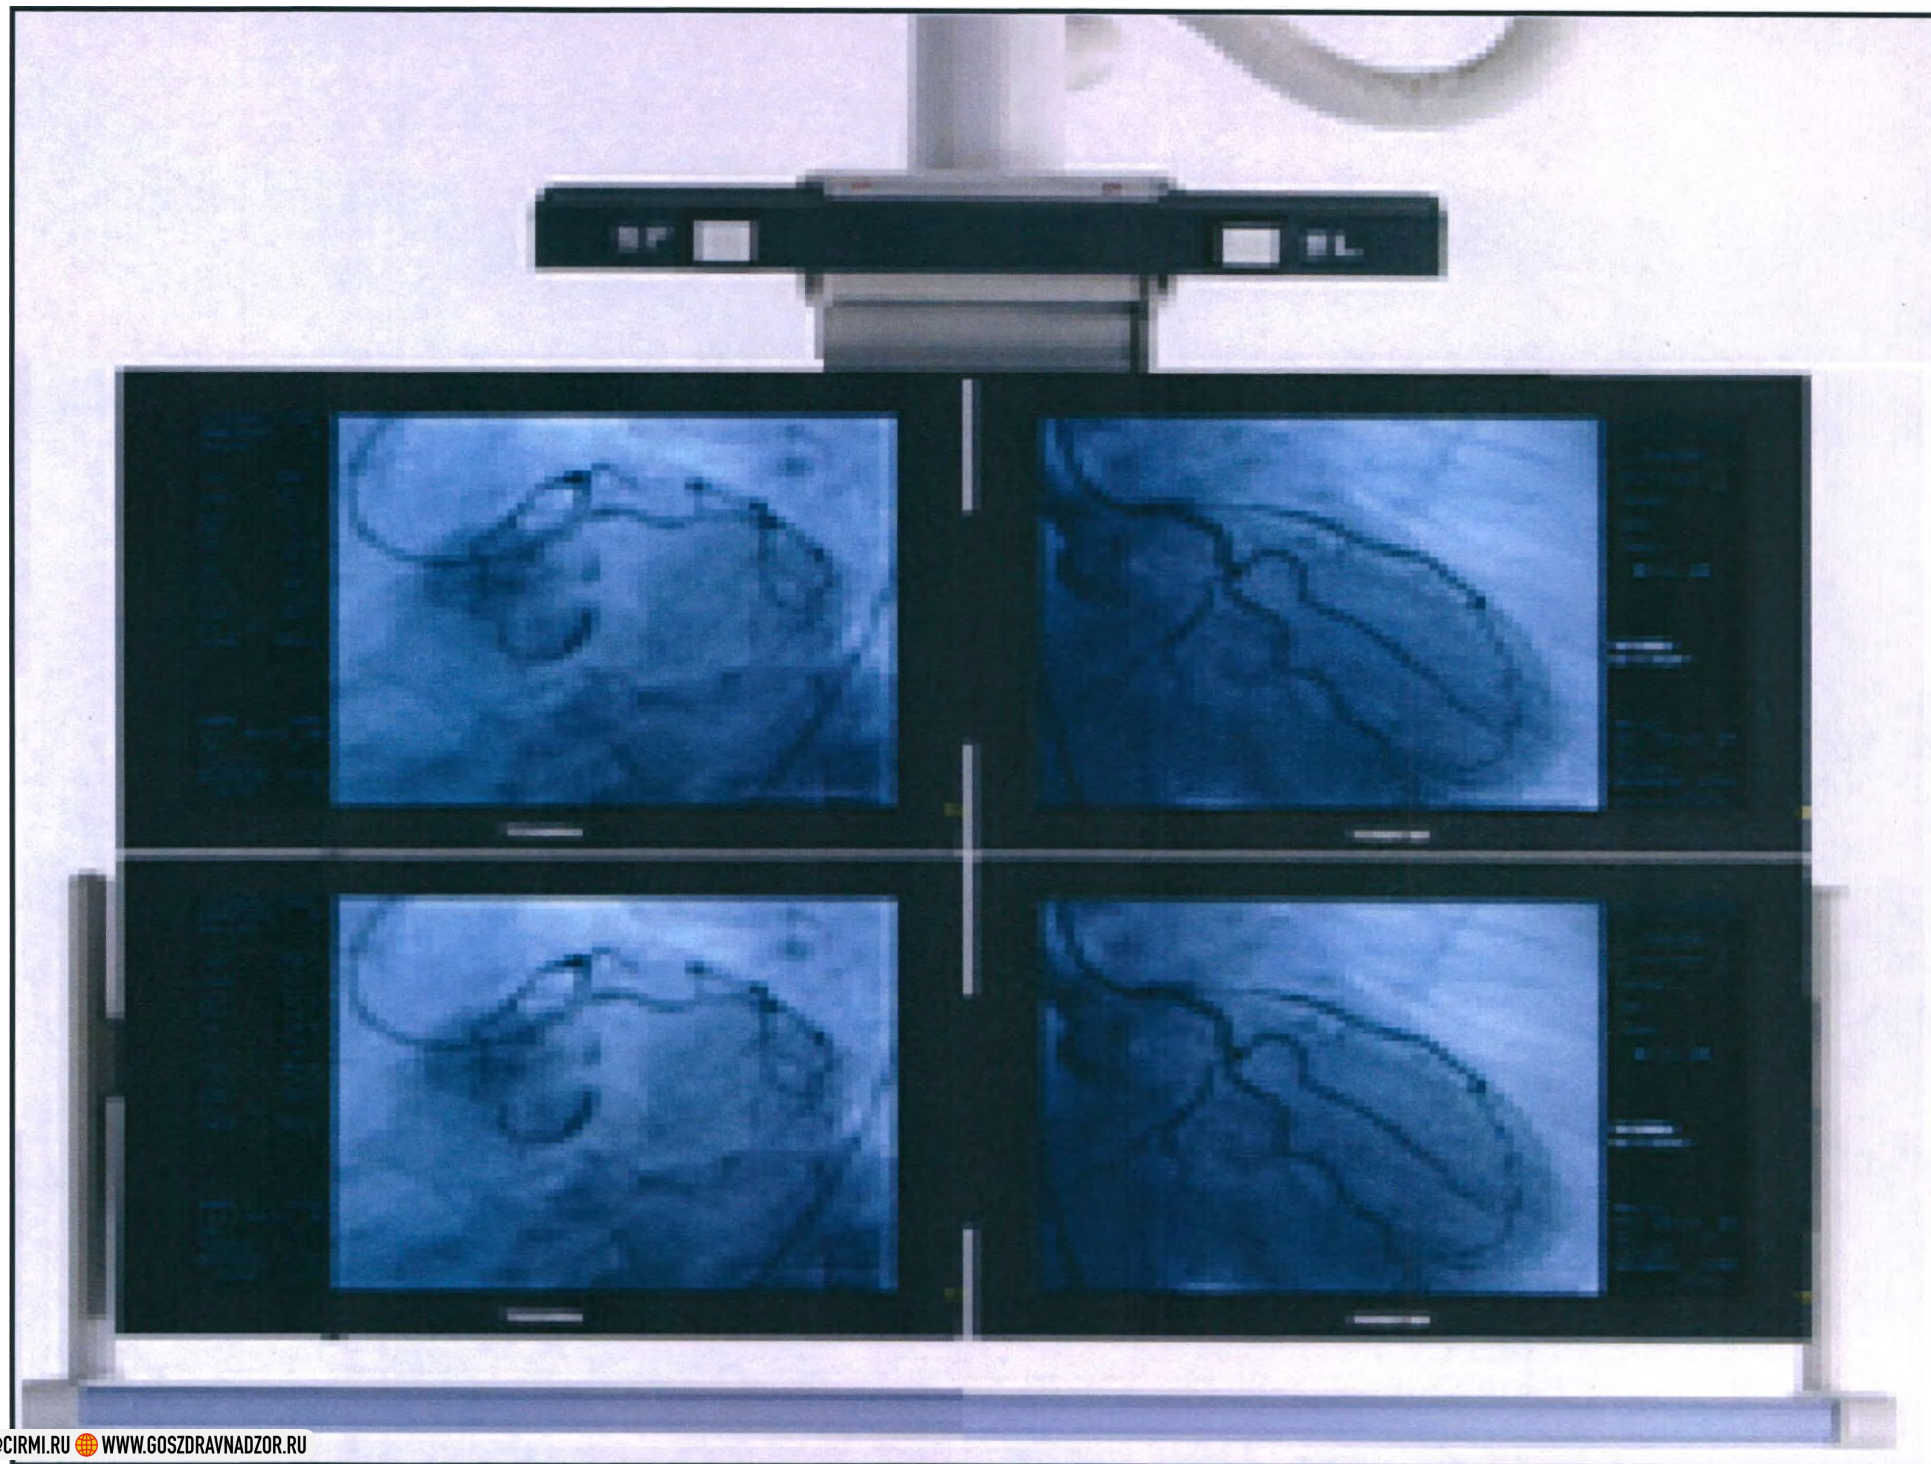


20. Подвесное устройство для мониторов.

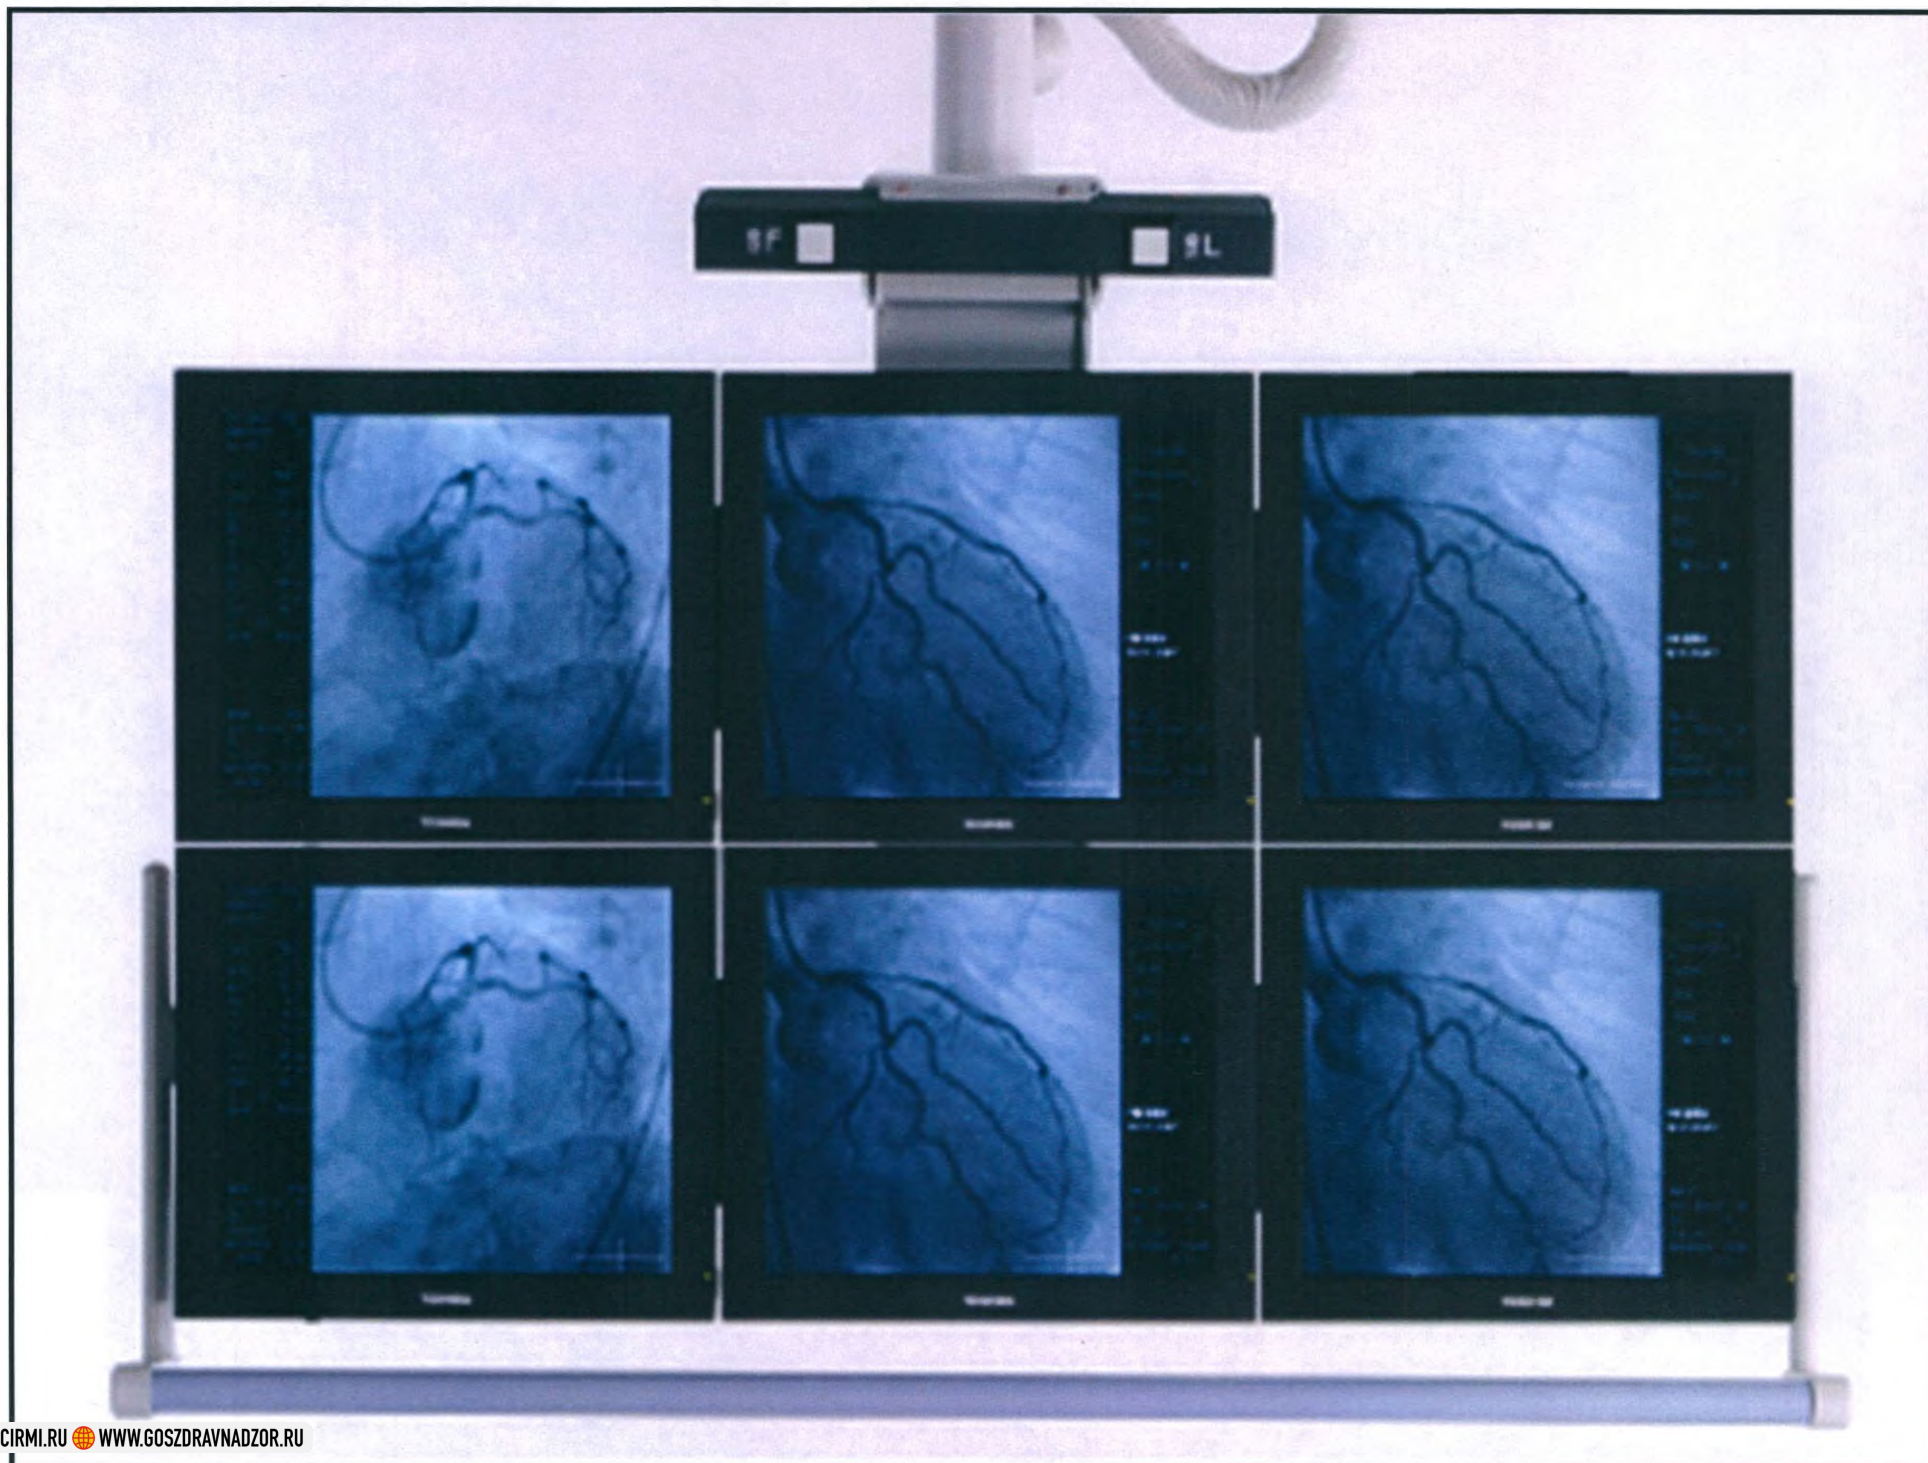


20. Подвесное устройство для мониторов.

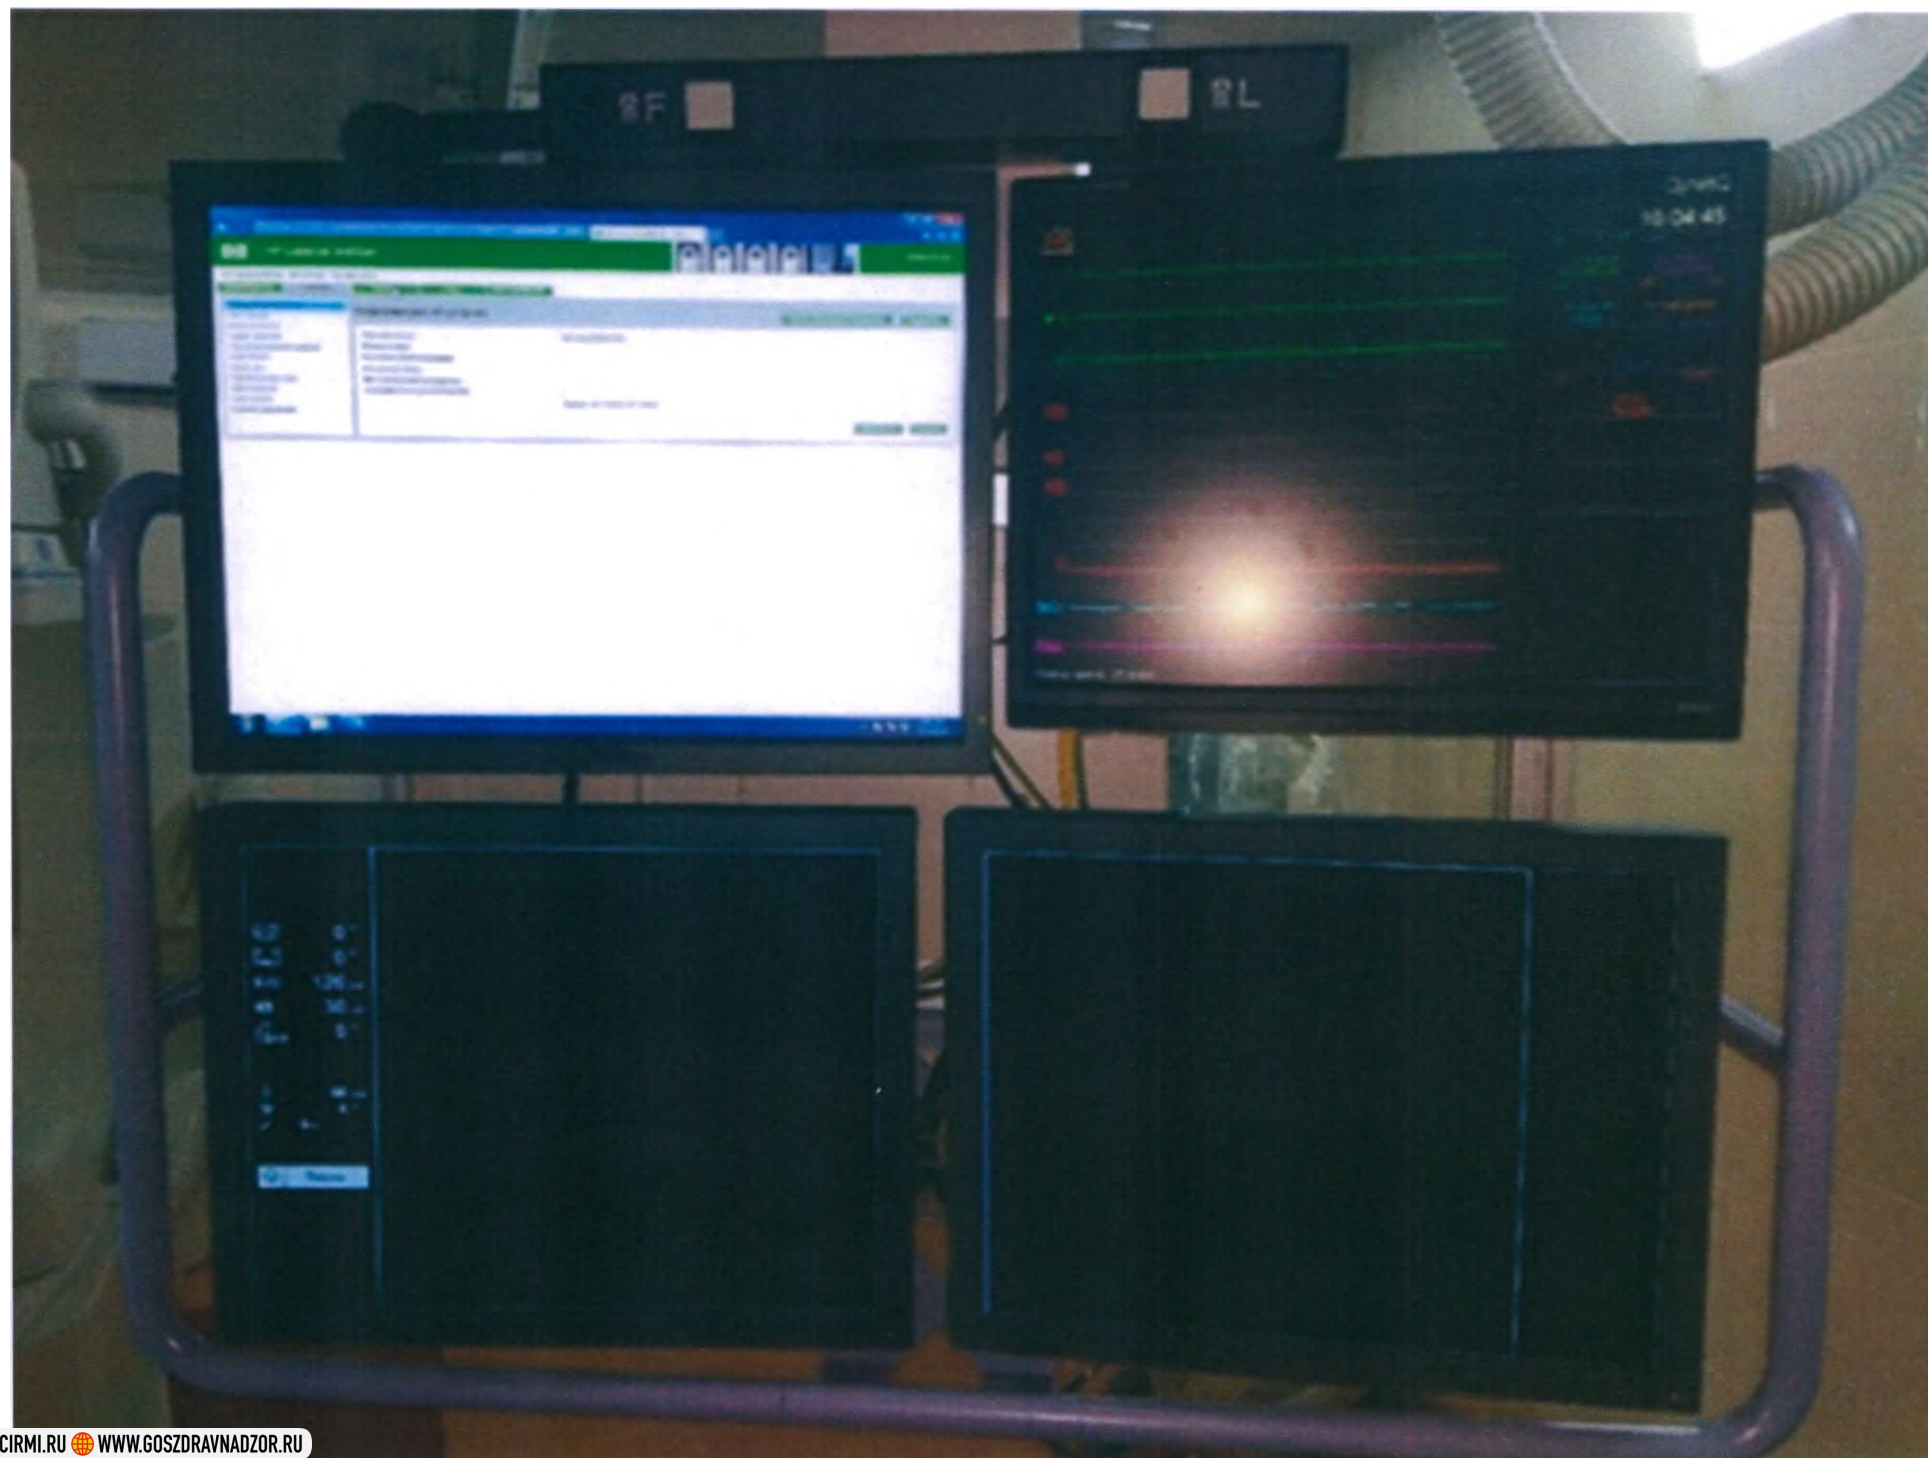

20. Подвесное устройство для мониторов.

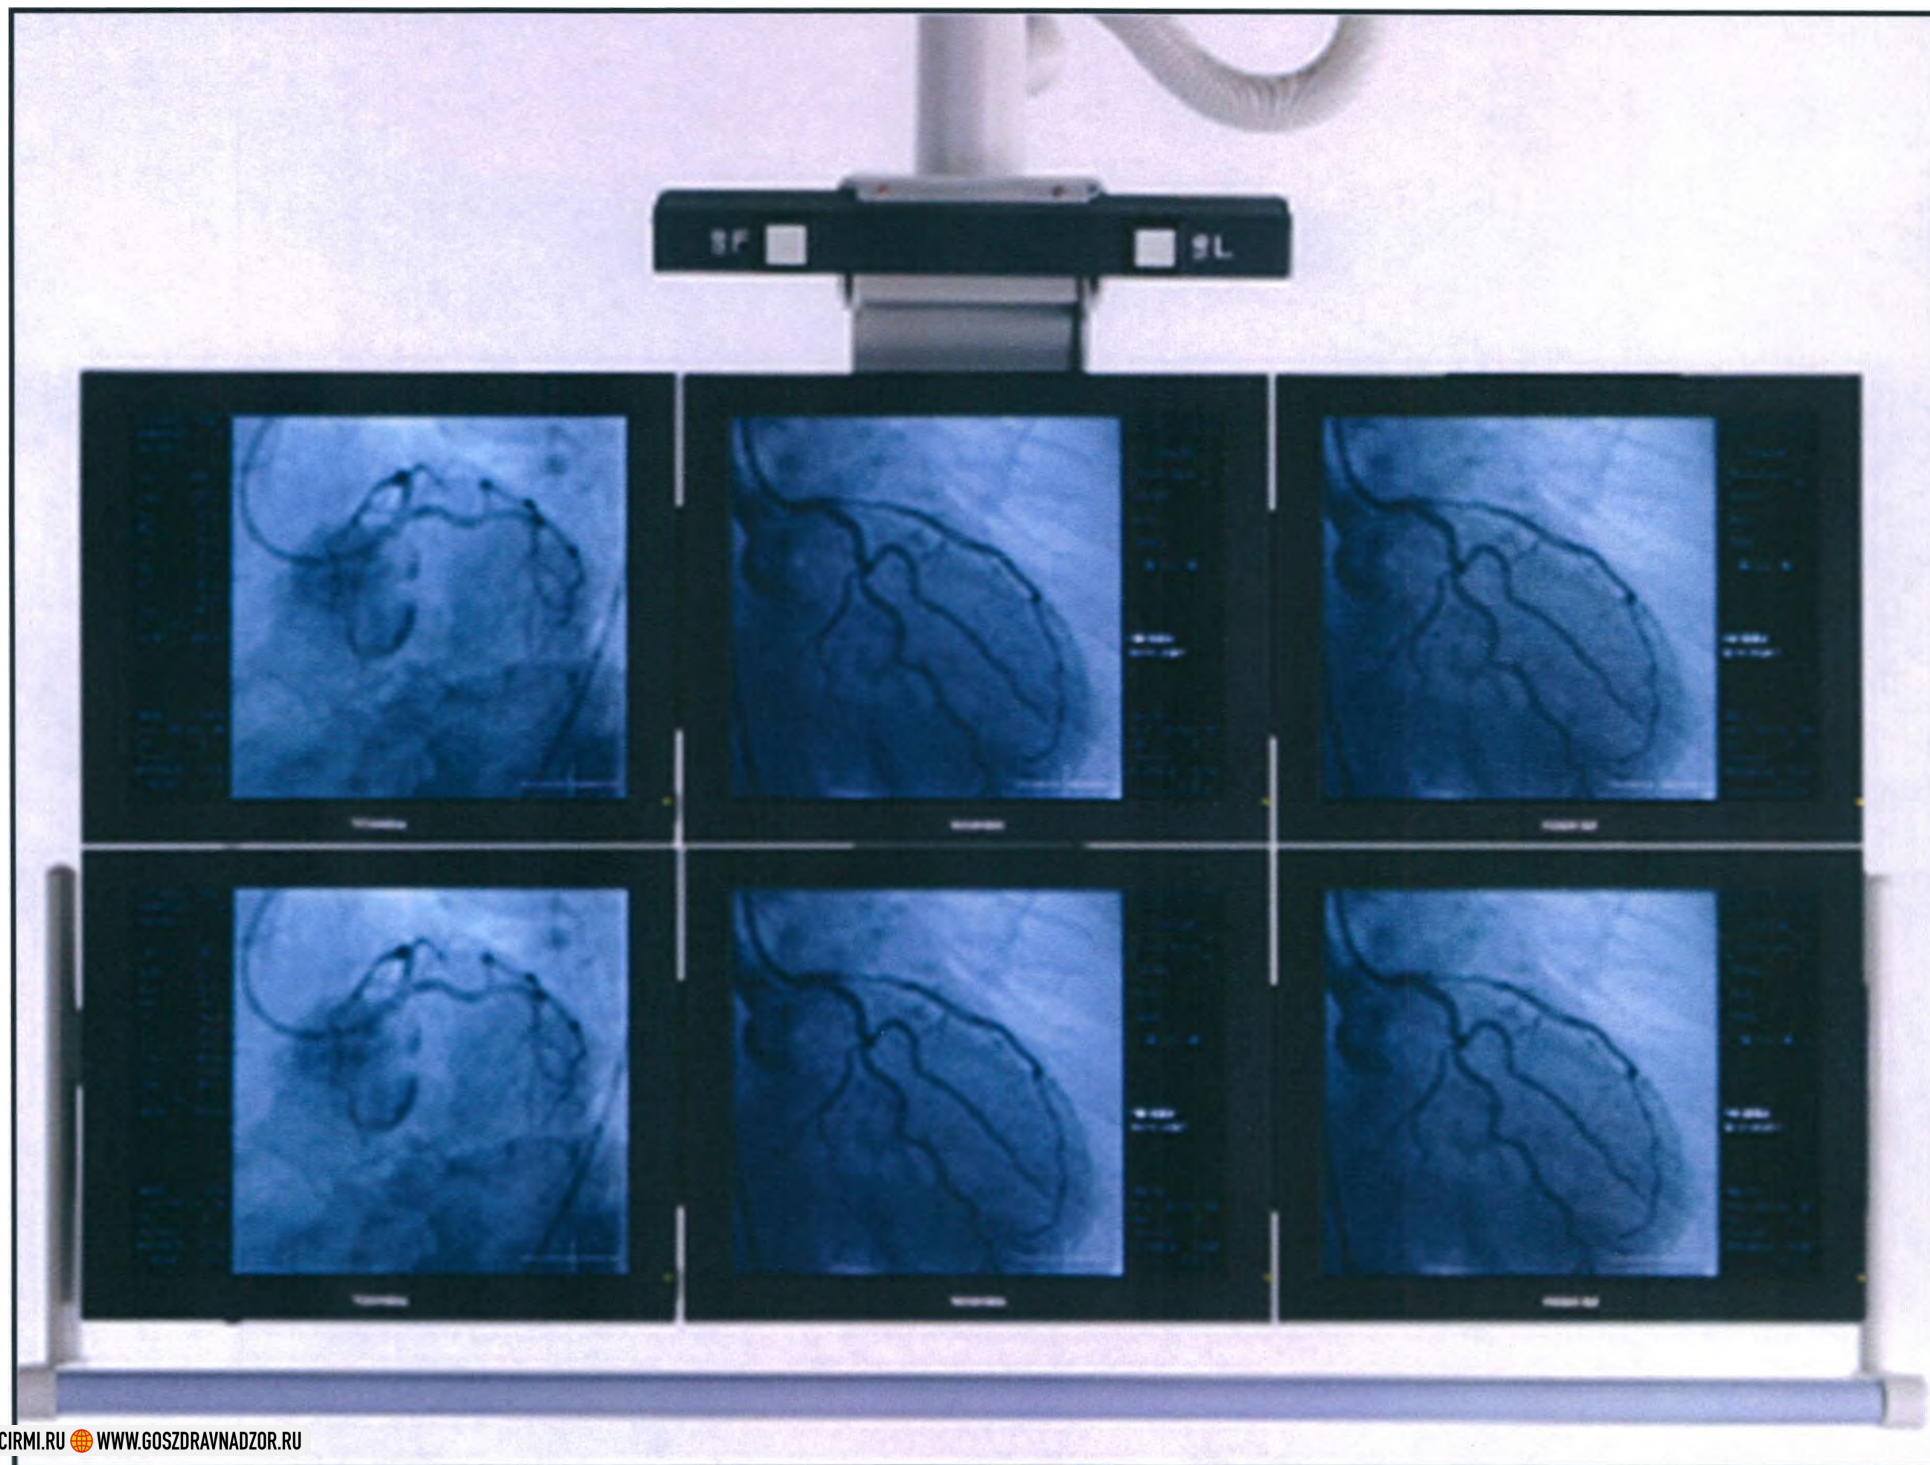


20. Подвесное устройство для мониторов.

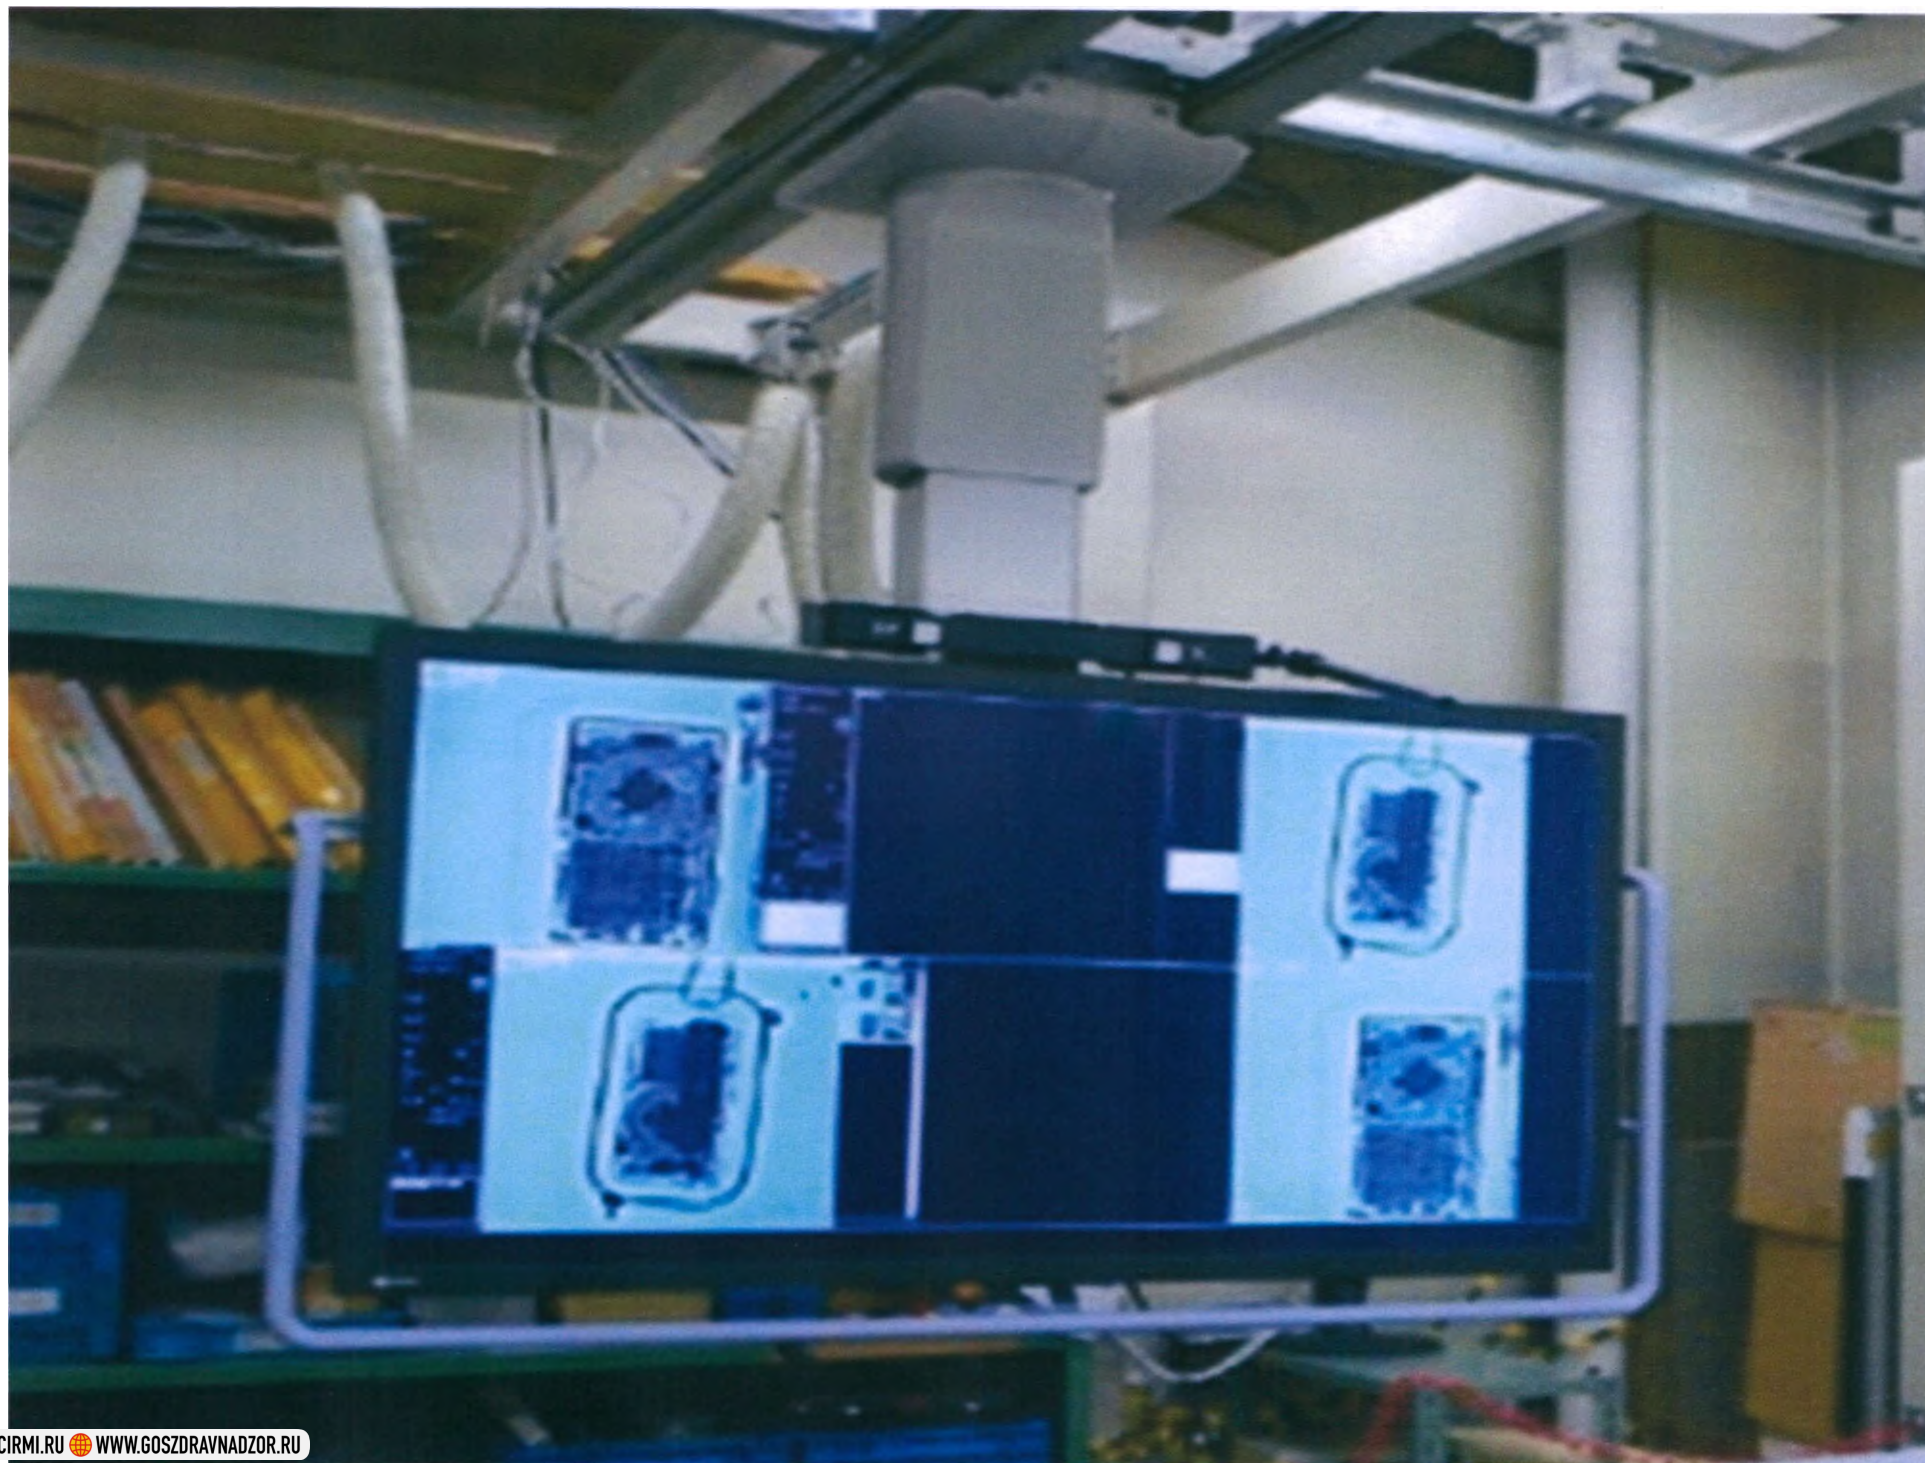

20. Подвесное устройство для мониторов.



21. Потолочные направляющие подвесного устройства для мониторов – 1 шт.

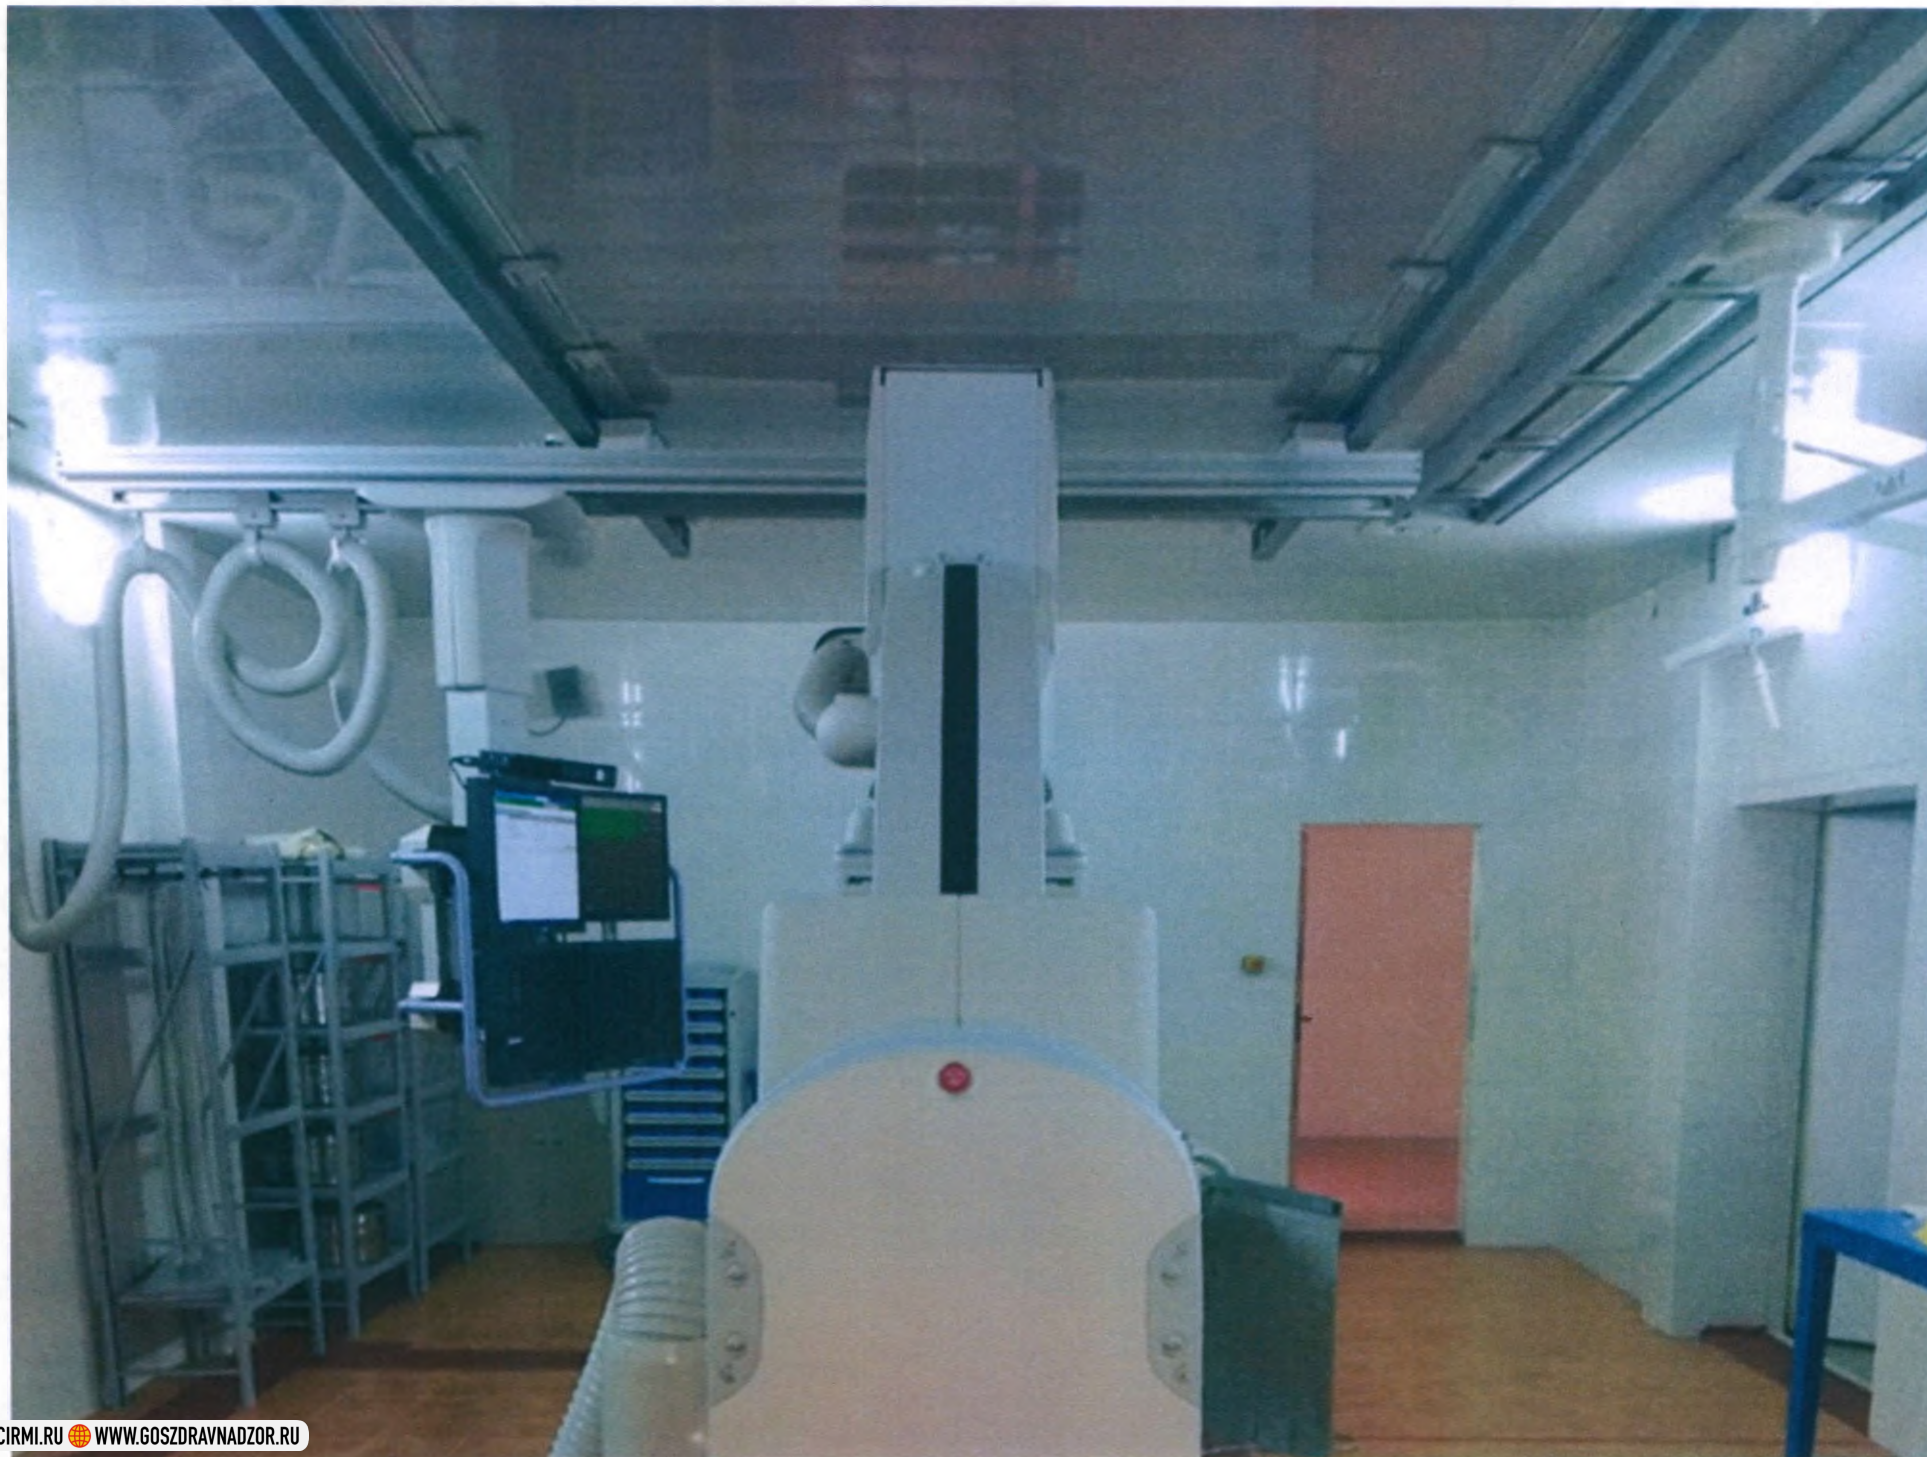



Микрофон в кабинете управления (talk microphone)



Усилитель звуковых сигналов в кабинете управления (talk amp)





Микрофон в кабинете сканирования (listen mic)




Усилитель звуковых сигналов в кабинете сканирования (listen amp)

23. Ионизационная камера дозиметра (производитель PTW-Freiburg, Германия).

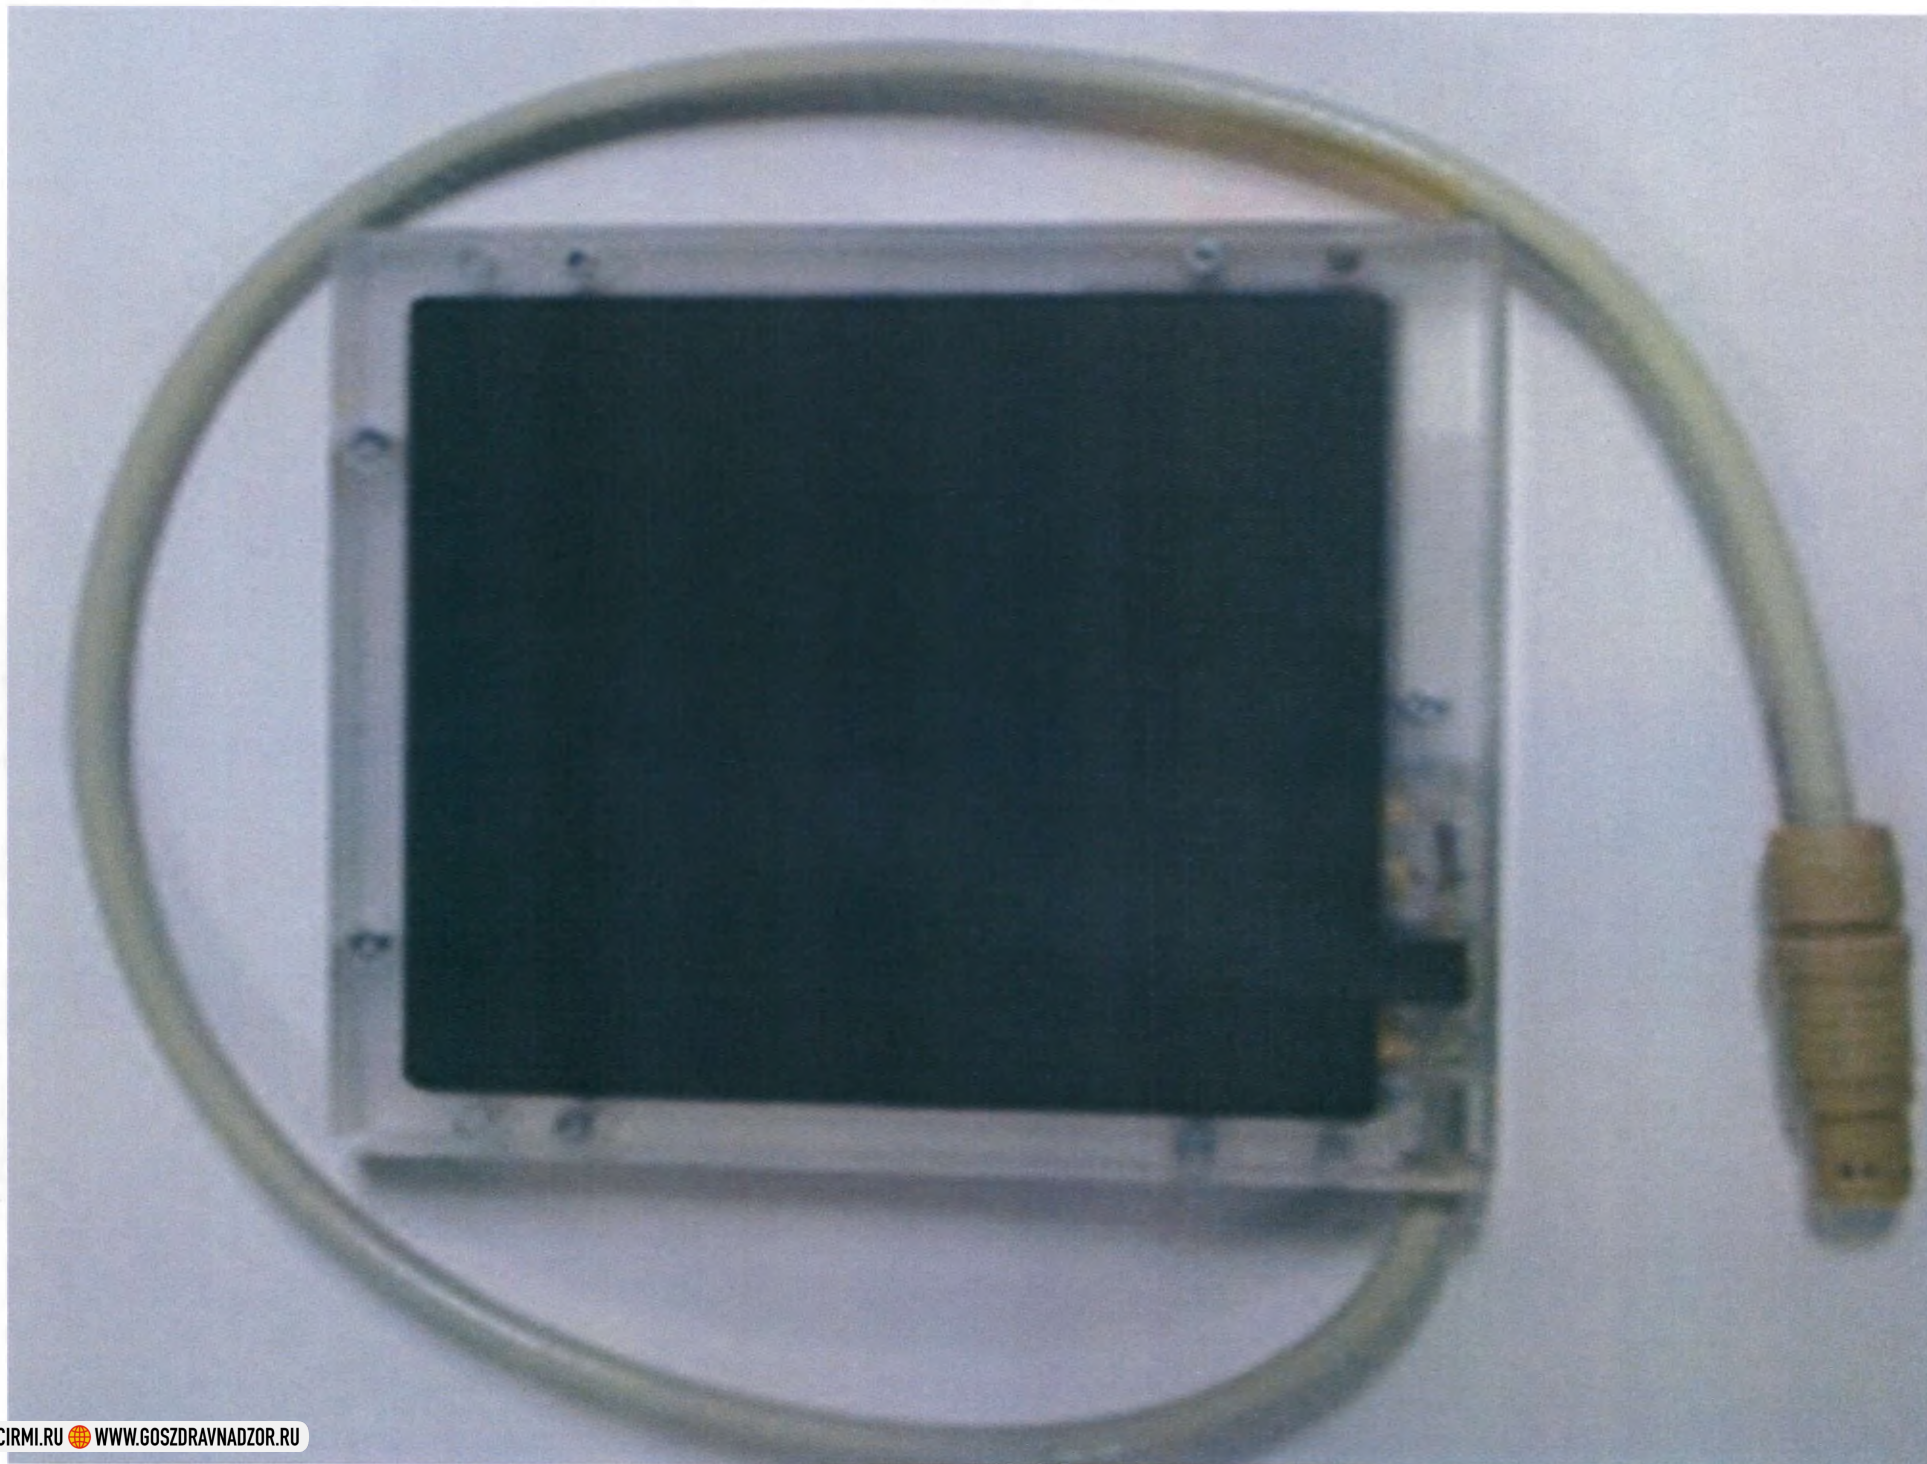


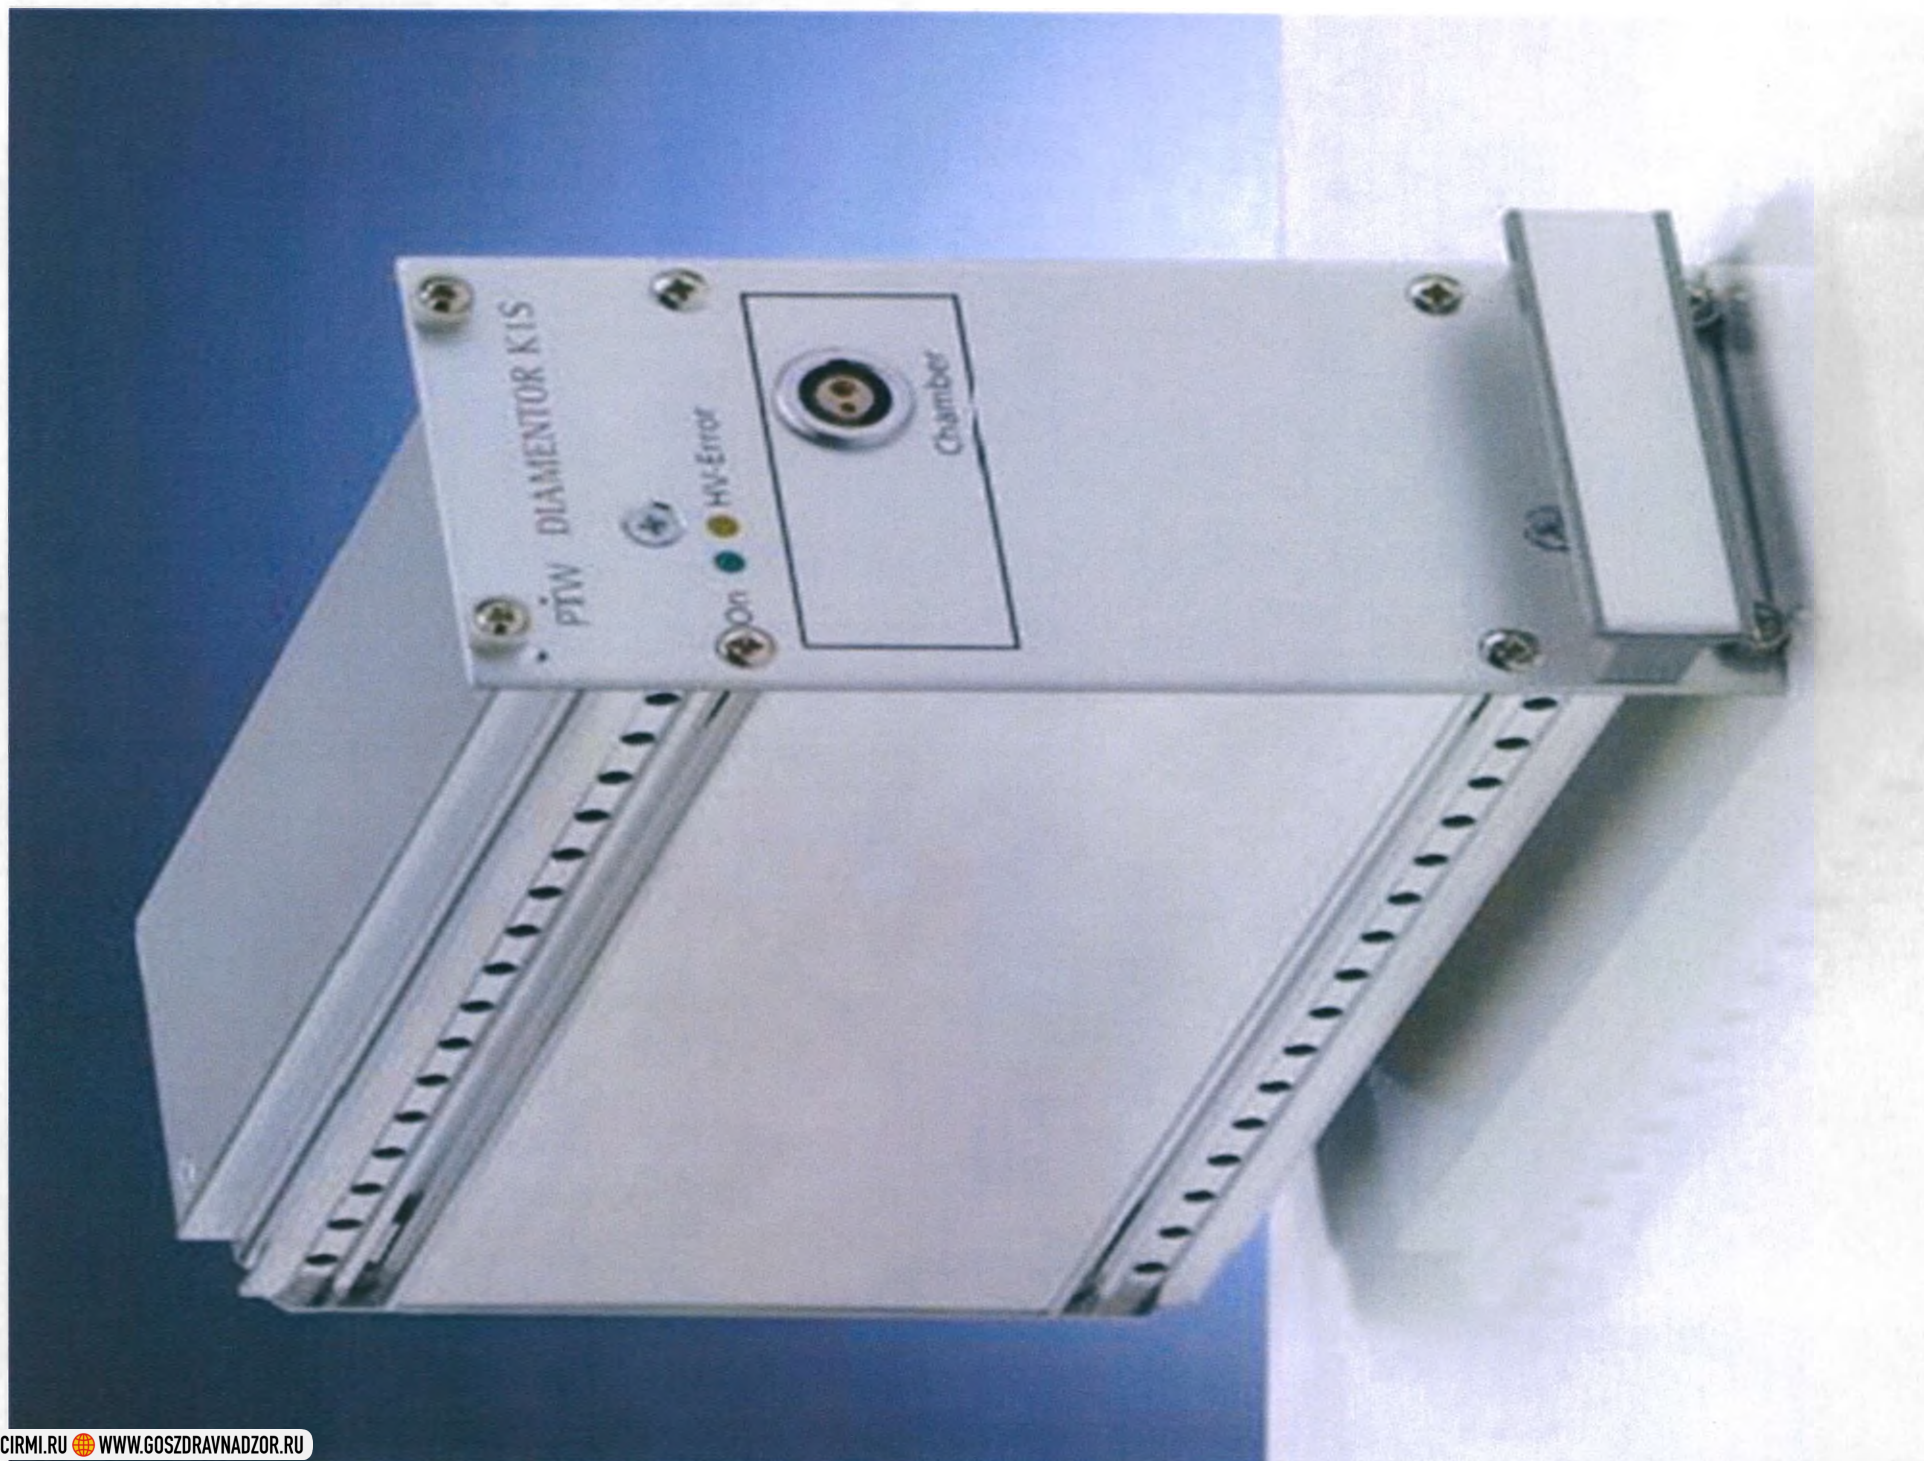


25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - усилитель – 1 шт.

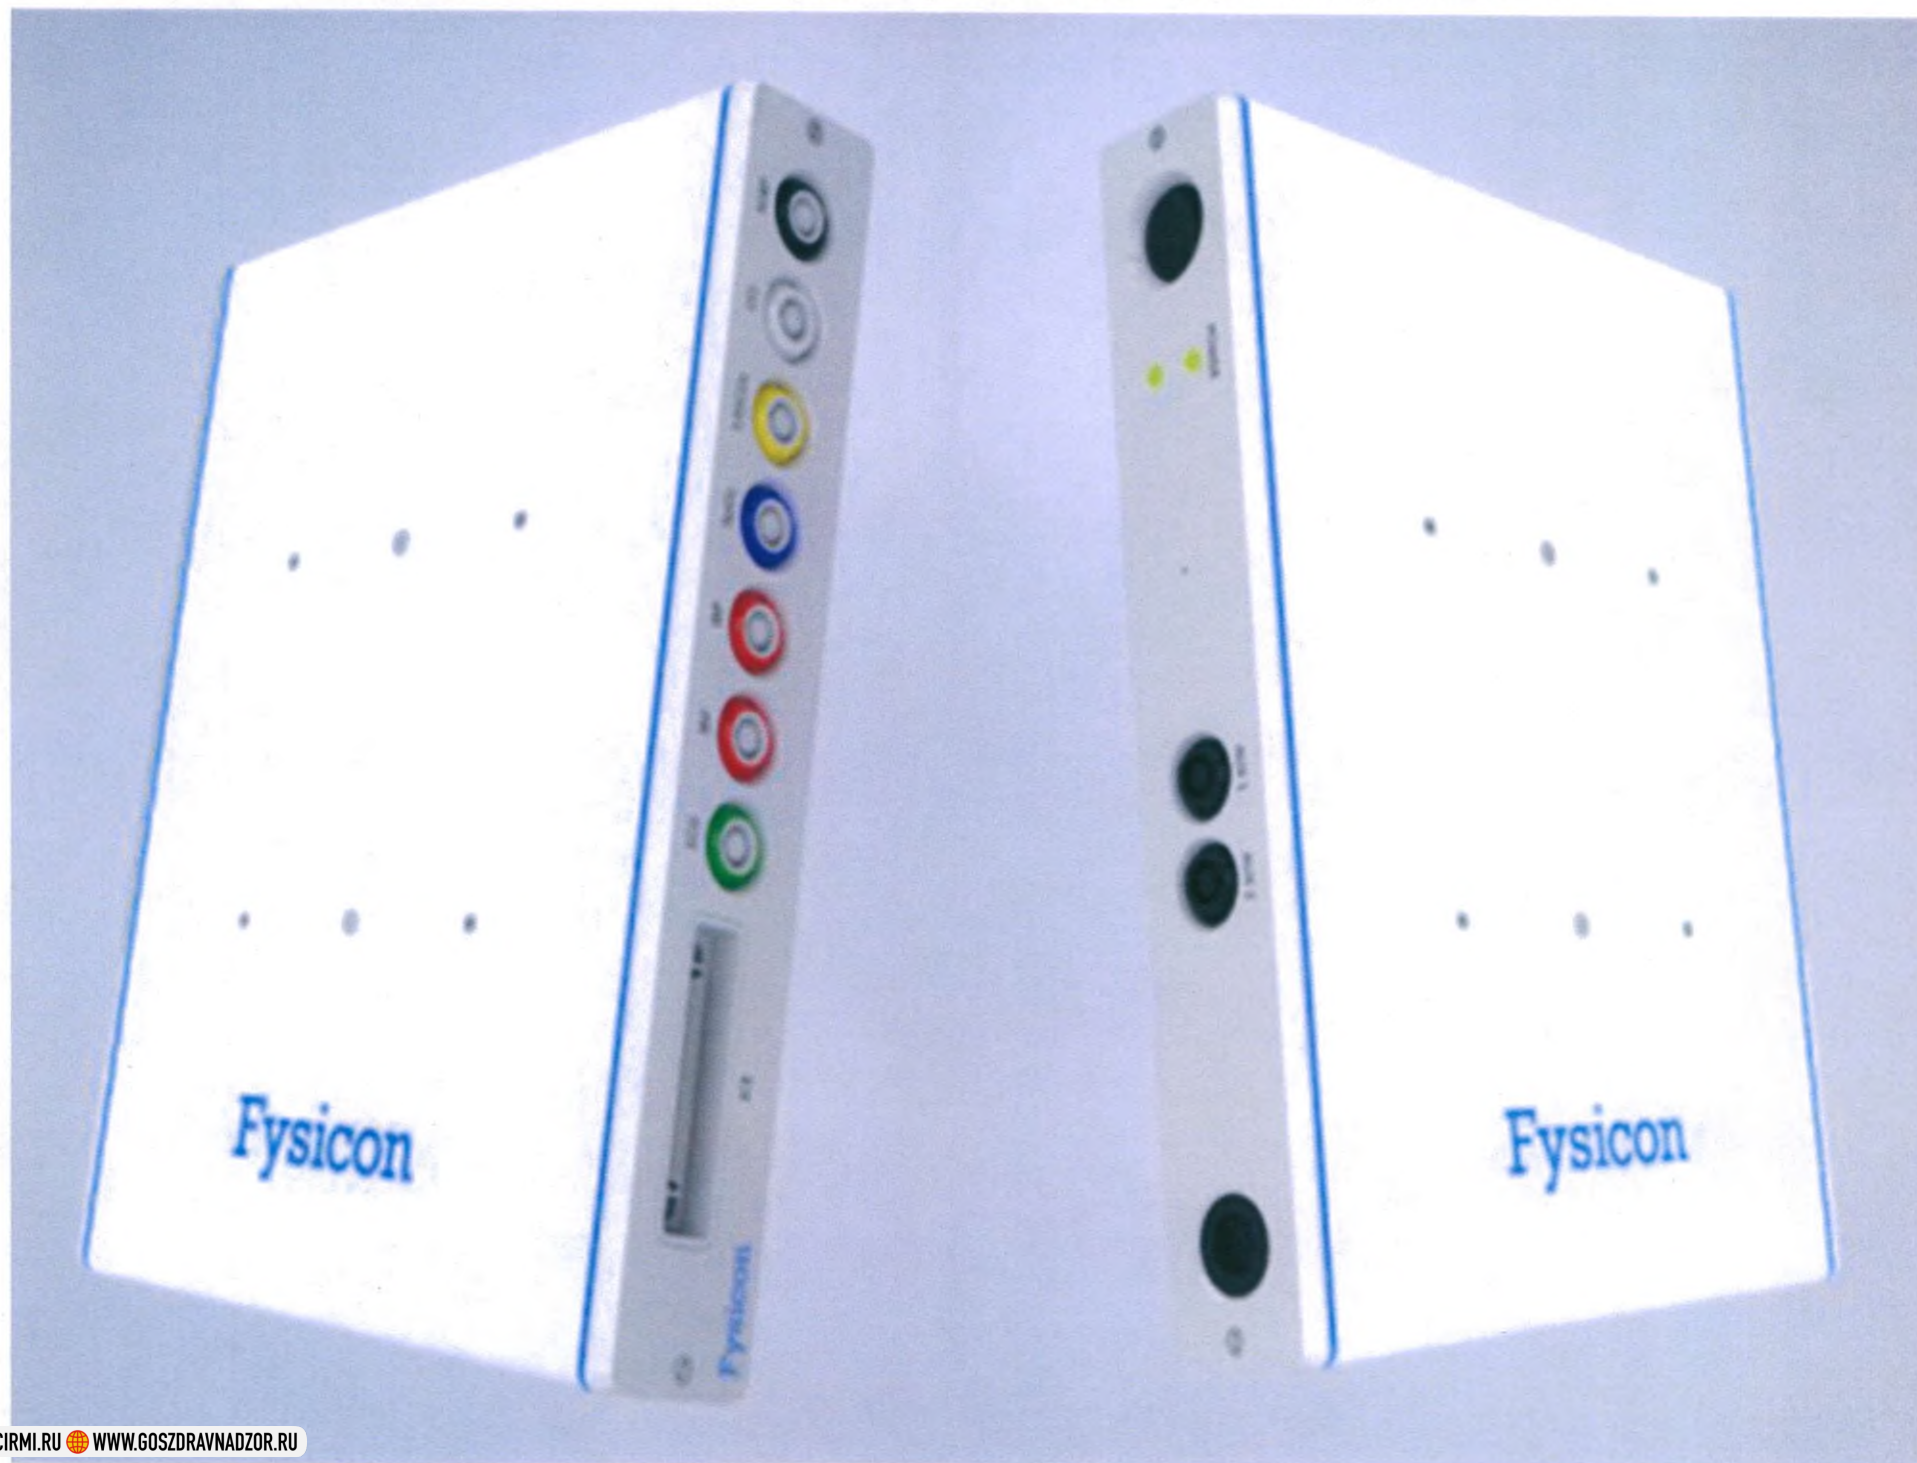



25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - крепеж для DIN-рейки - 1 шт.;

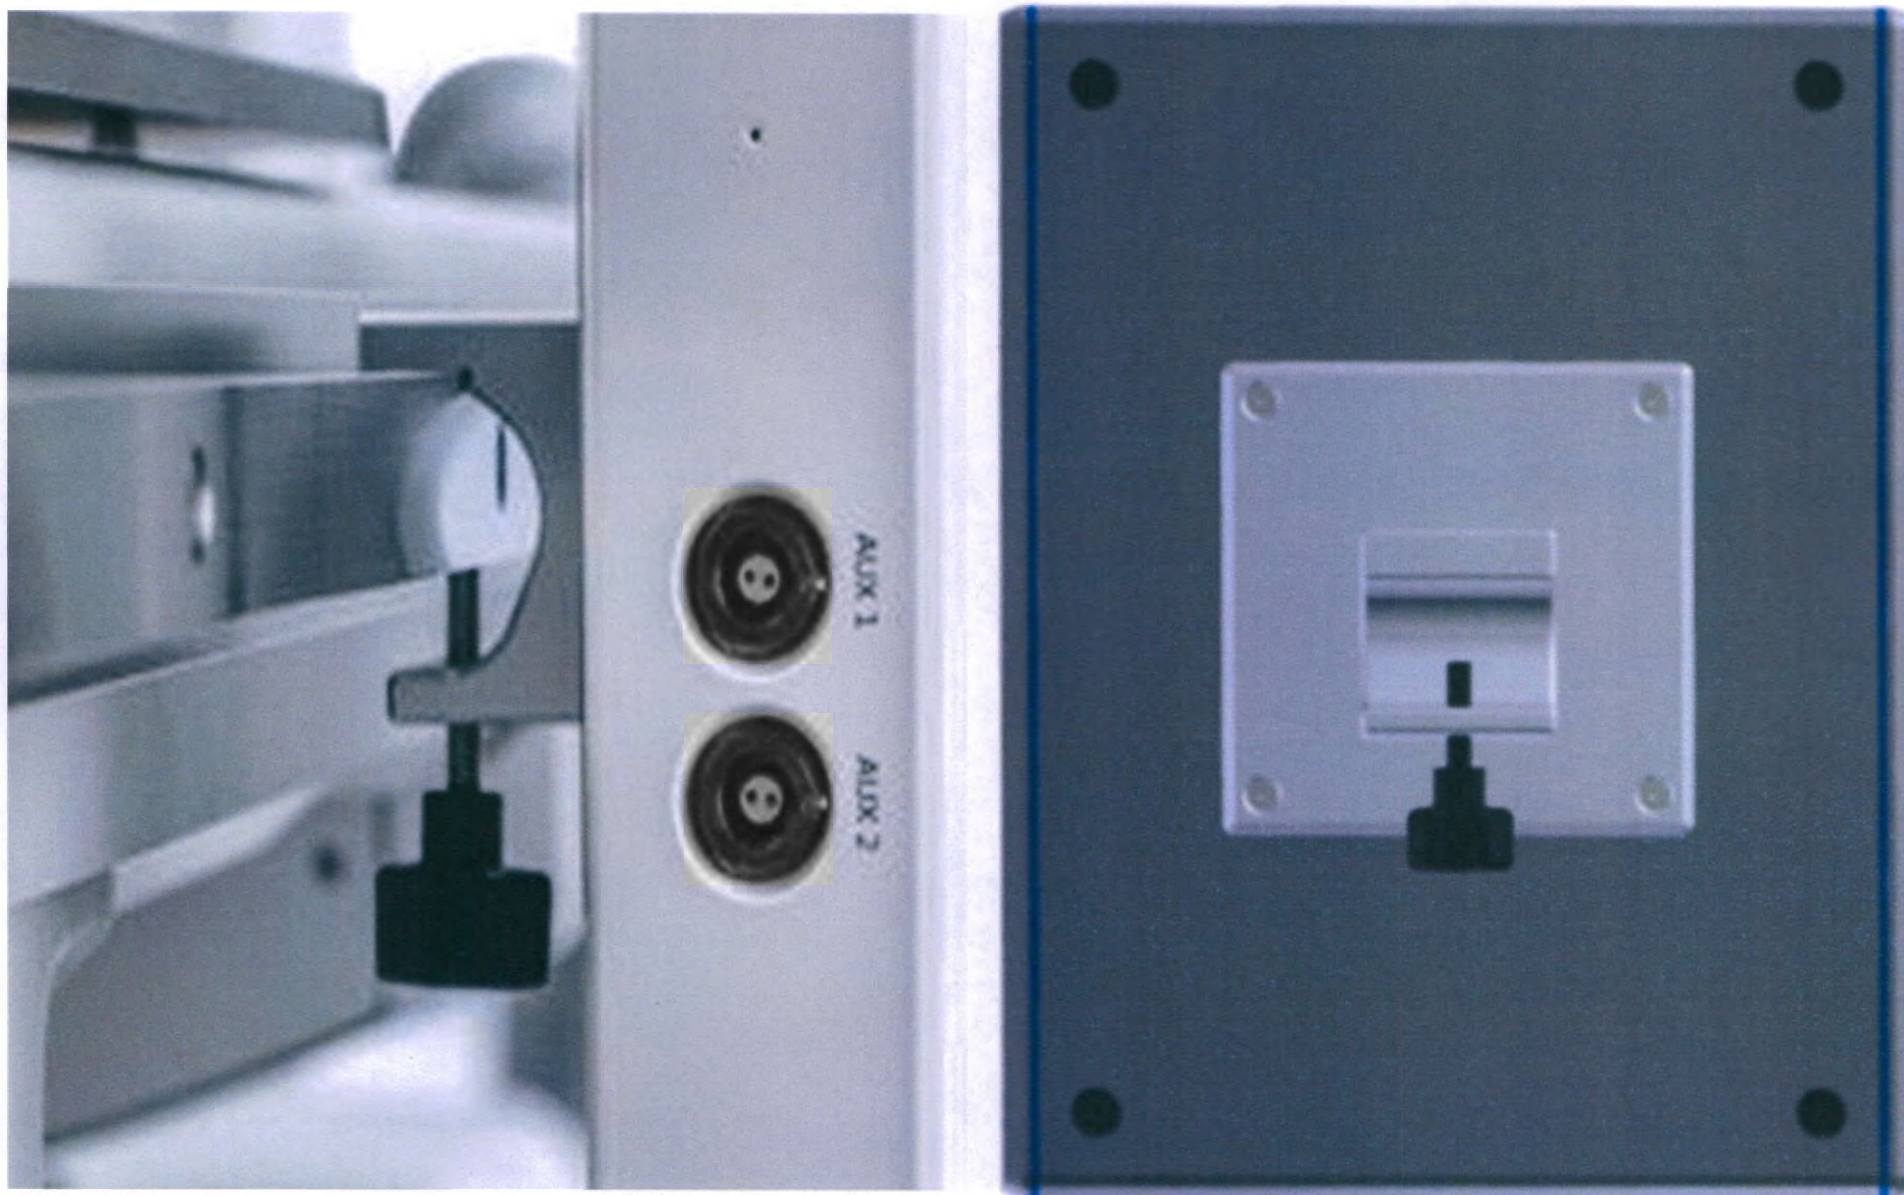

25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - процессор отчетов – 1 шт.; - процессор для работы в реальном времени (при необходимости), 1 шт.;

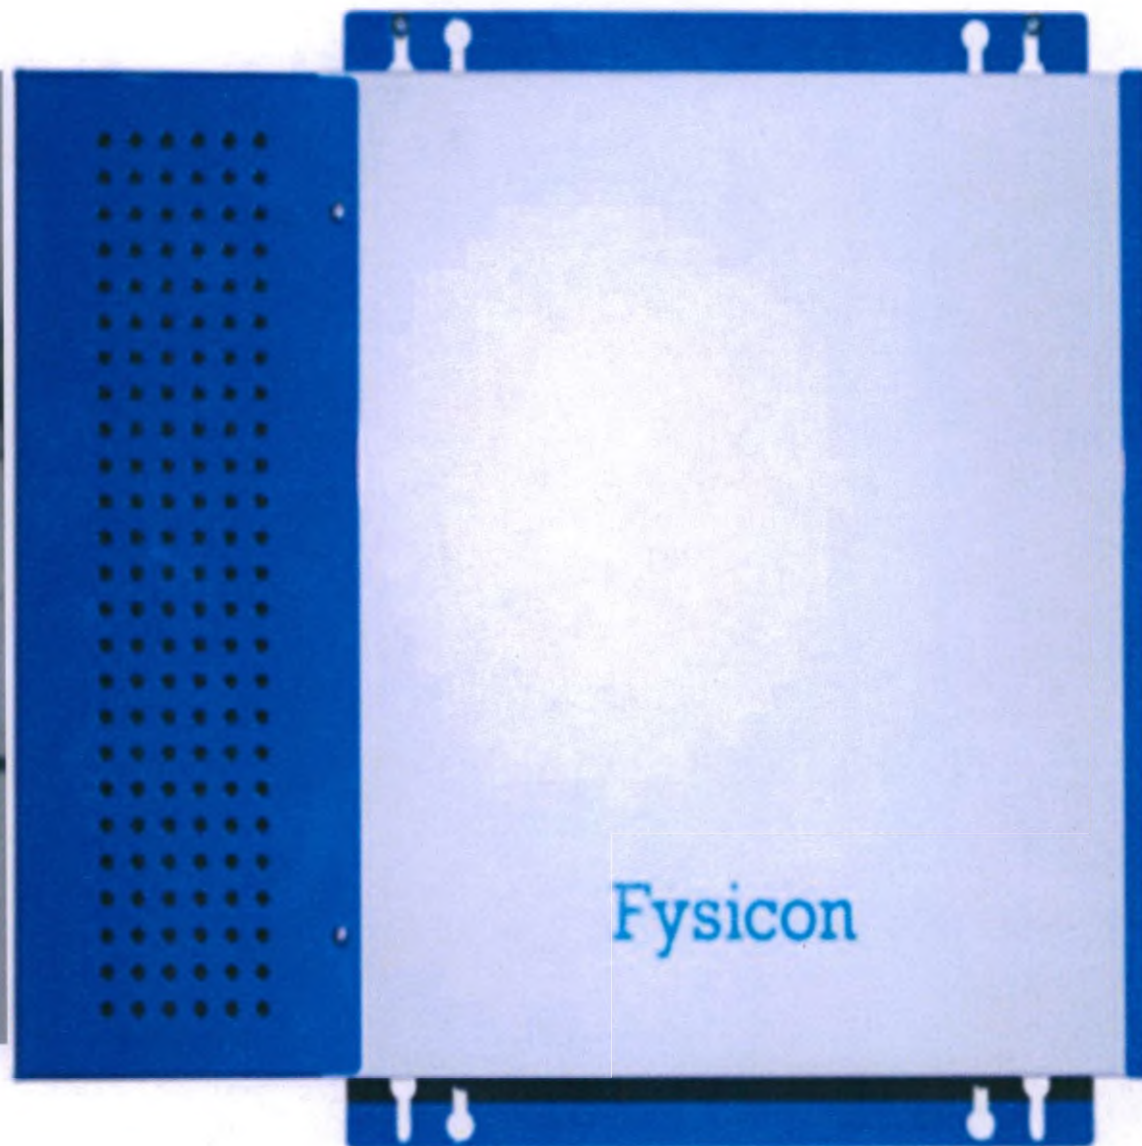

25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - кабель системы, не более 3 шт.

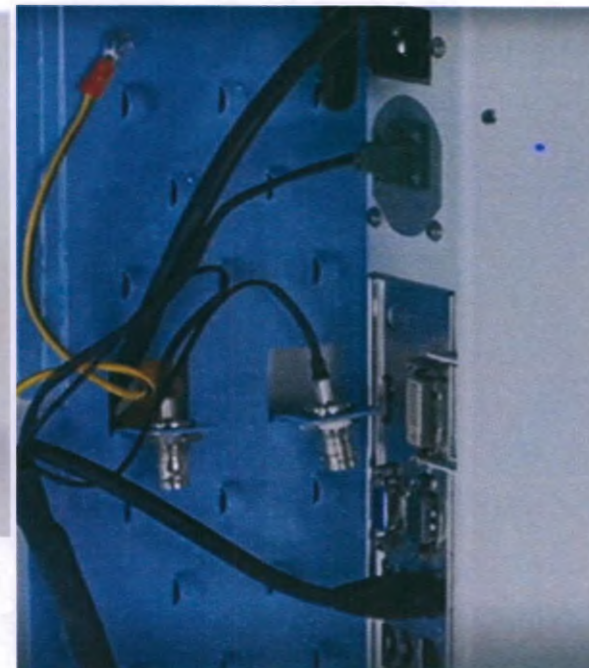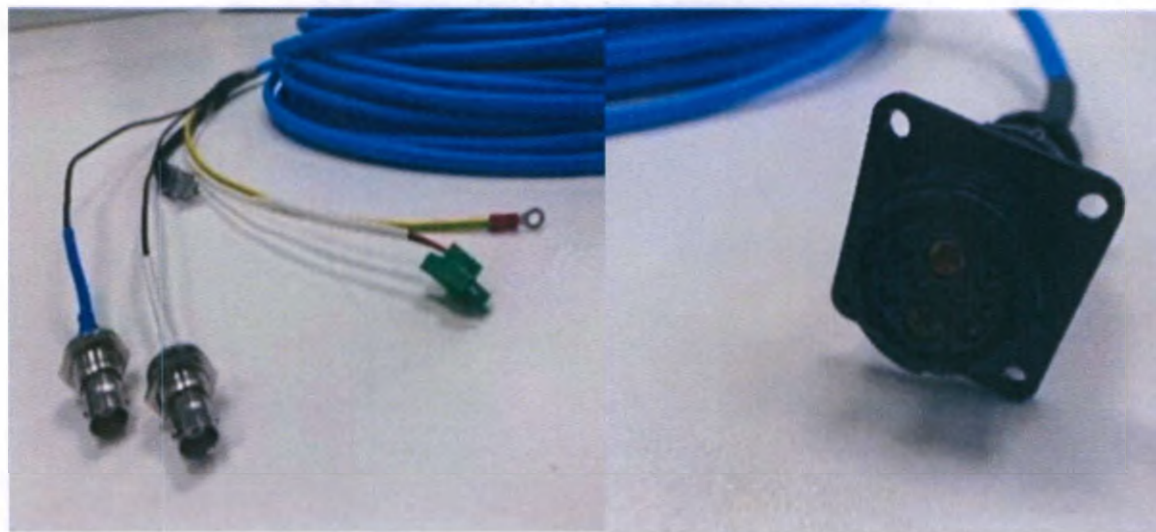

Кабель системы синий



Кабель системы белый

Кабель информационный зеленый

25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - адаптер питания, не более 3 шт.



Canon

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Alphenix

МОДЕЛЬ INFX-8000V/B, INFX-8000V/Y,
INFX-8000V/P

ВАЖНО!

Перед эксплуатацией оборудования ознакомьтесь
с настоящим руководством. После прочтения
держите руководство в легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION


© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2018–2020

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Принадлежности: 1. Вспомогательная консоль.



Принадлежности: 1. Вспомогательная консоль (Подставка).

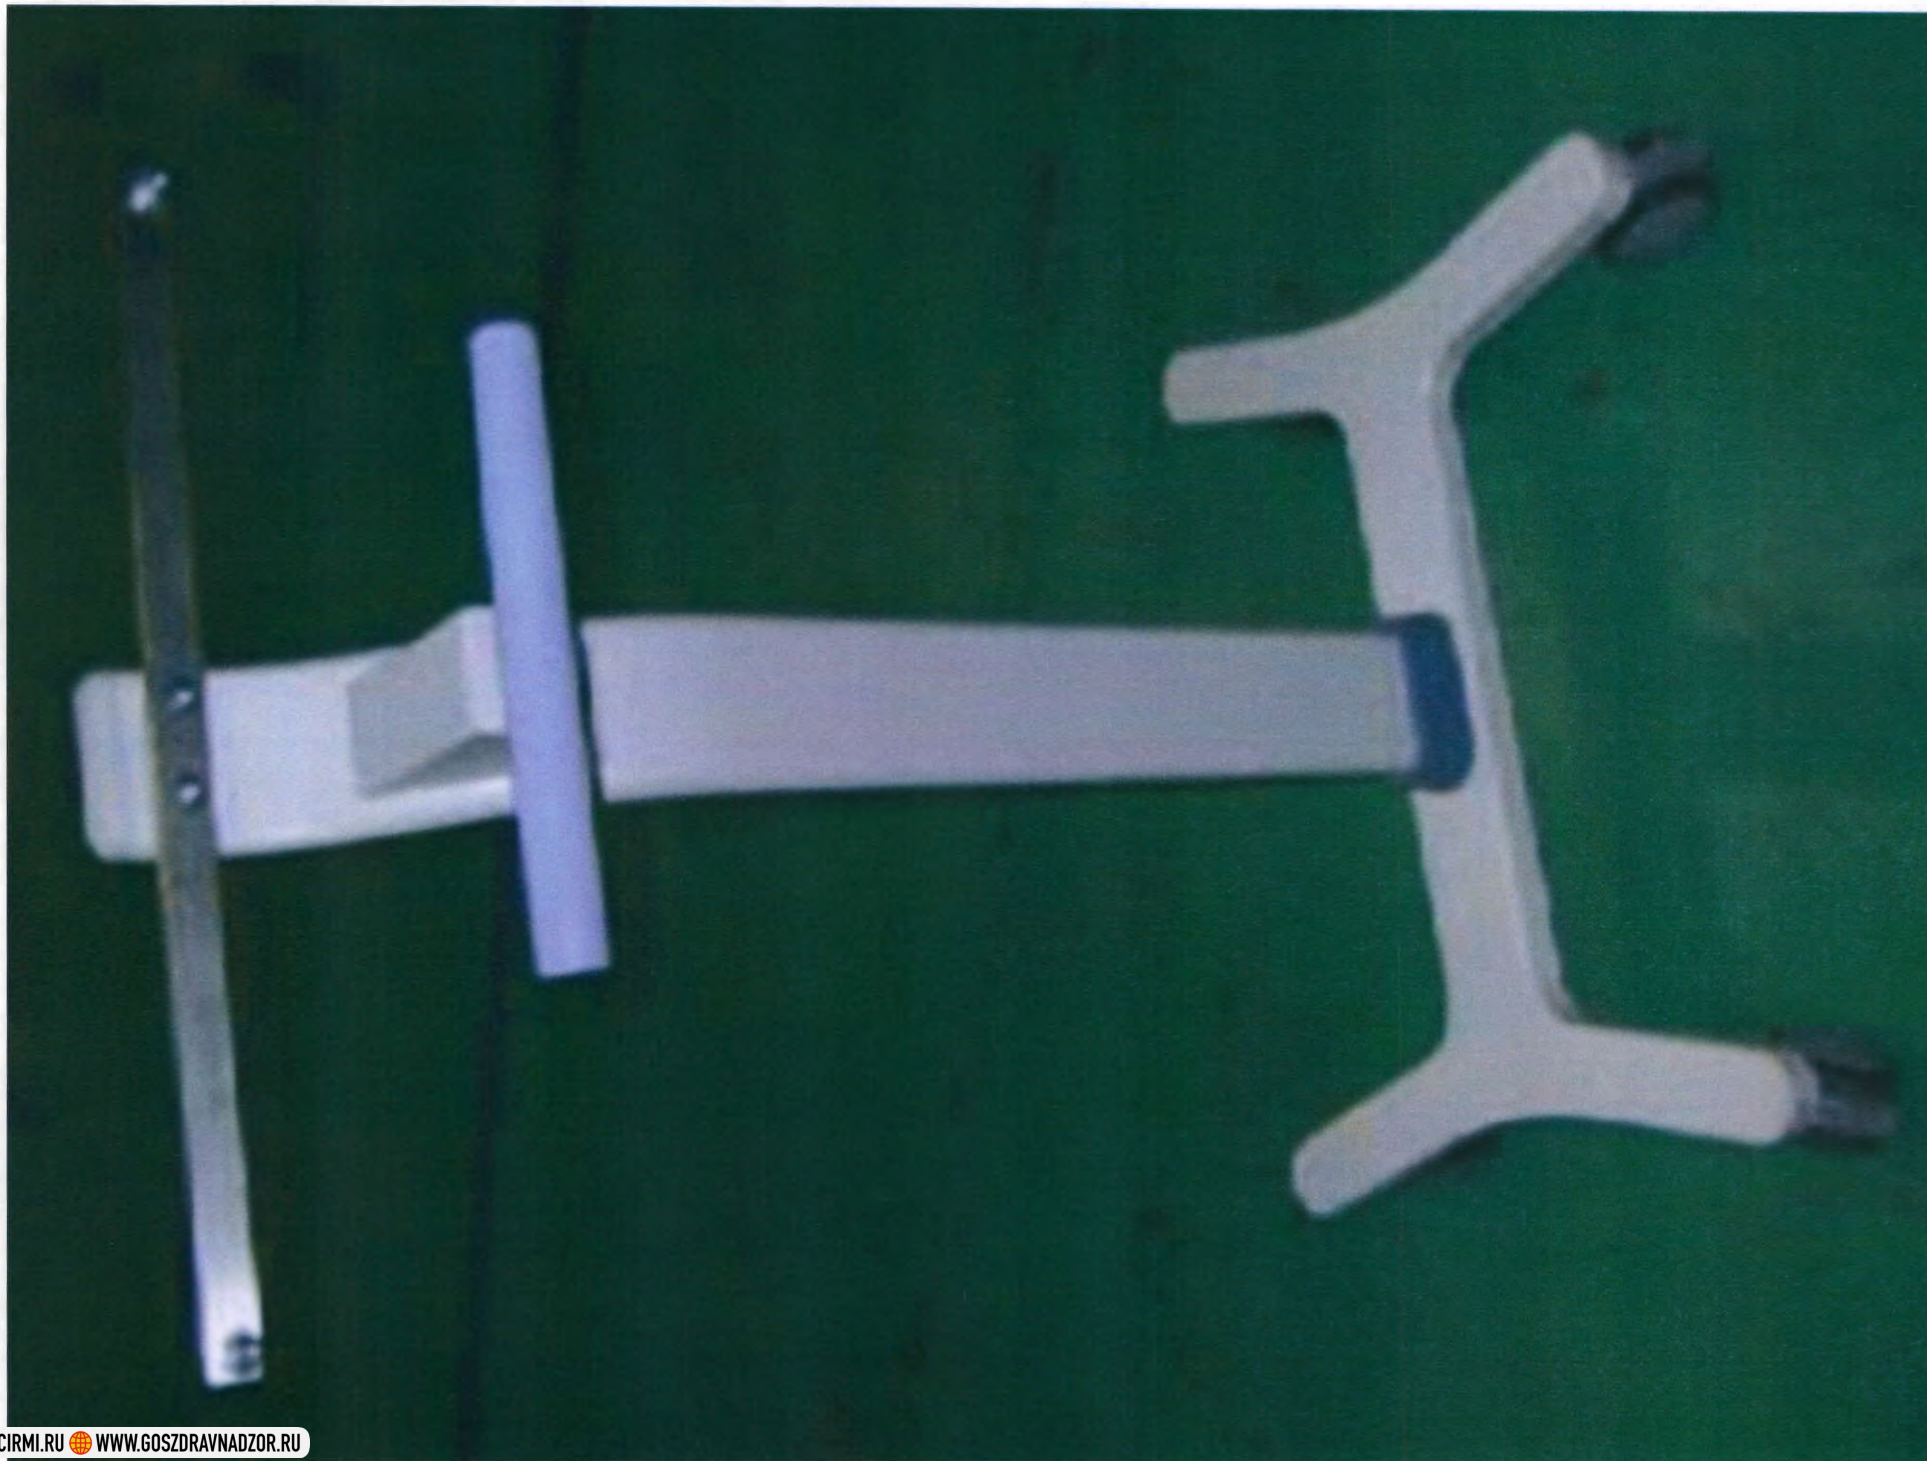


2. Боковая консоль стола (для использования в сочетании с планшетной консолью).




3. Вспомогательная консоль (для использования в сочетании с планшетной консолью).



4. Опорная плита для CAS-880A, 1400 мм.

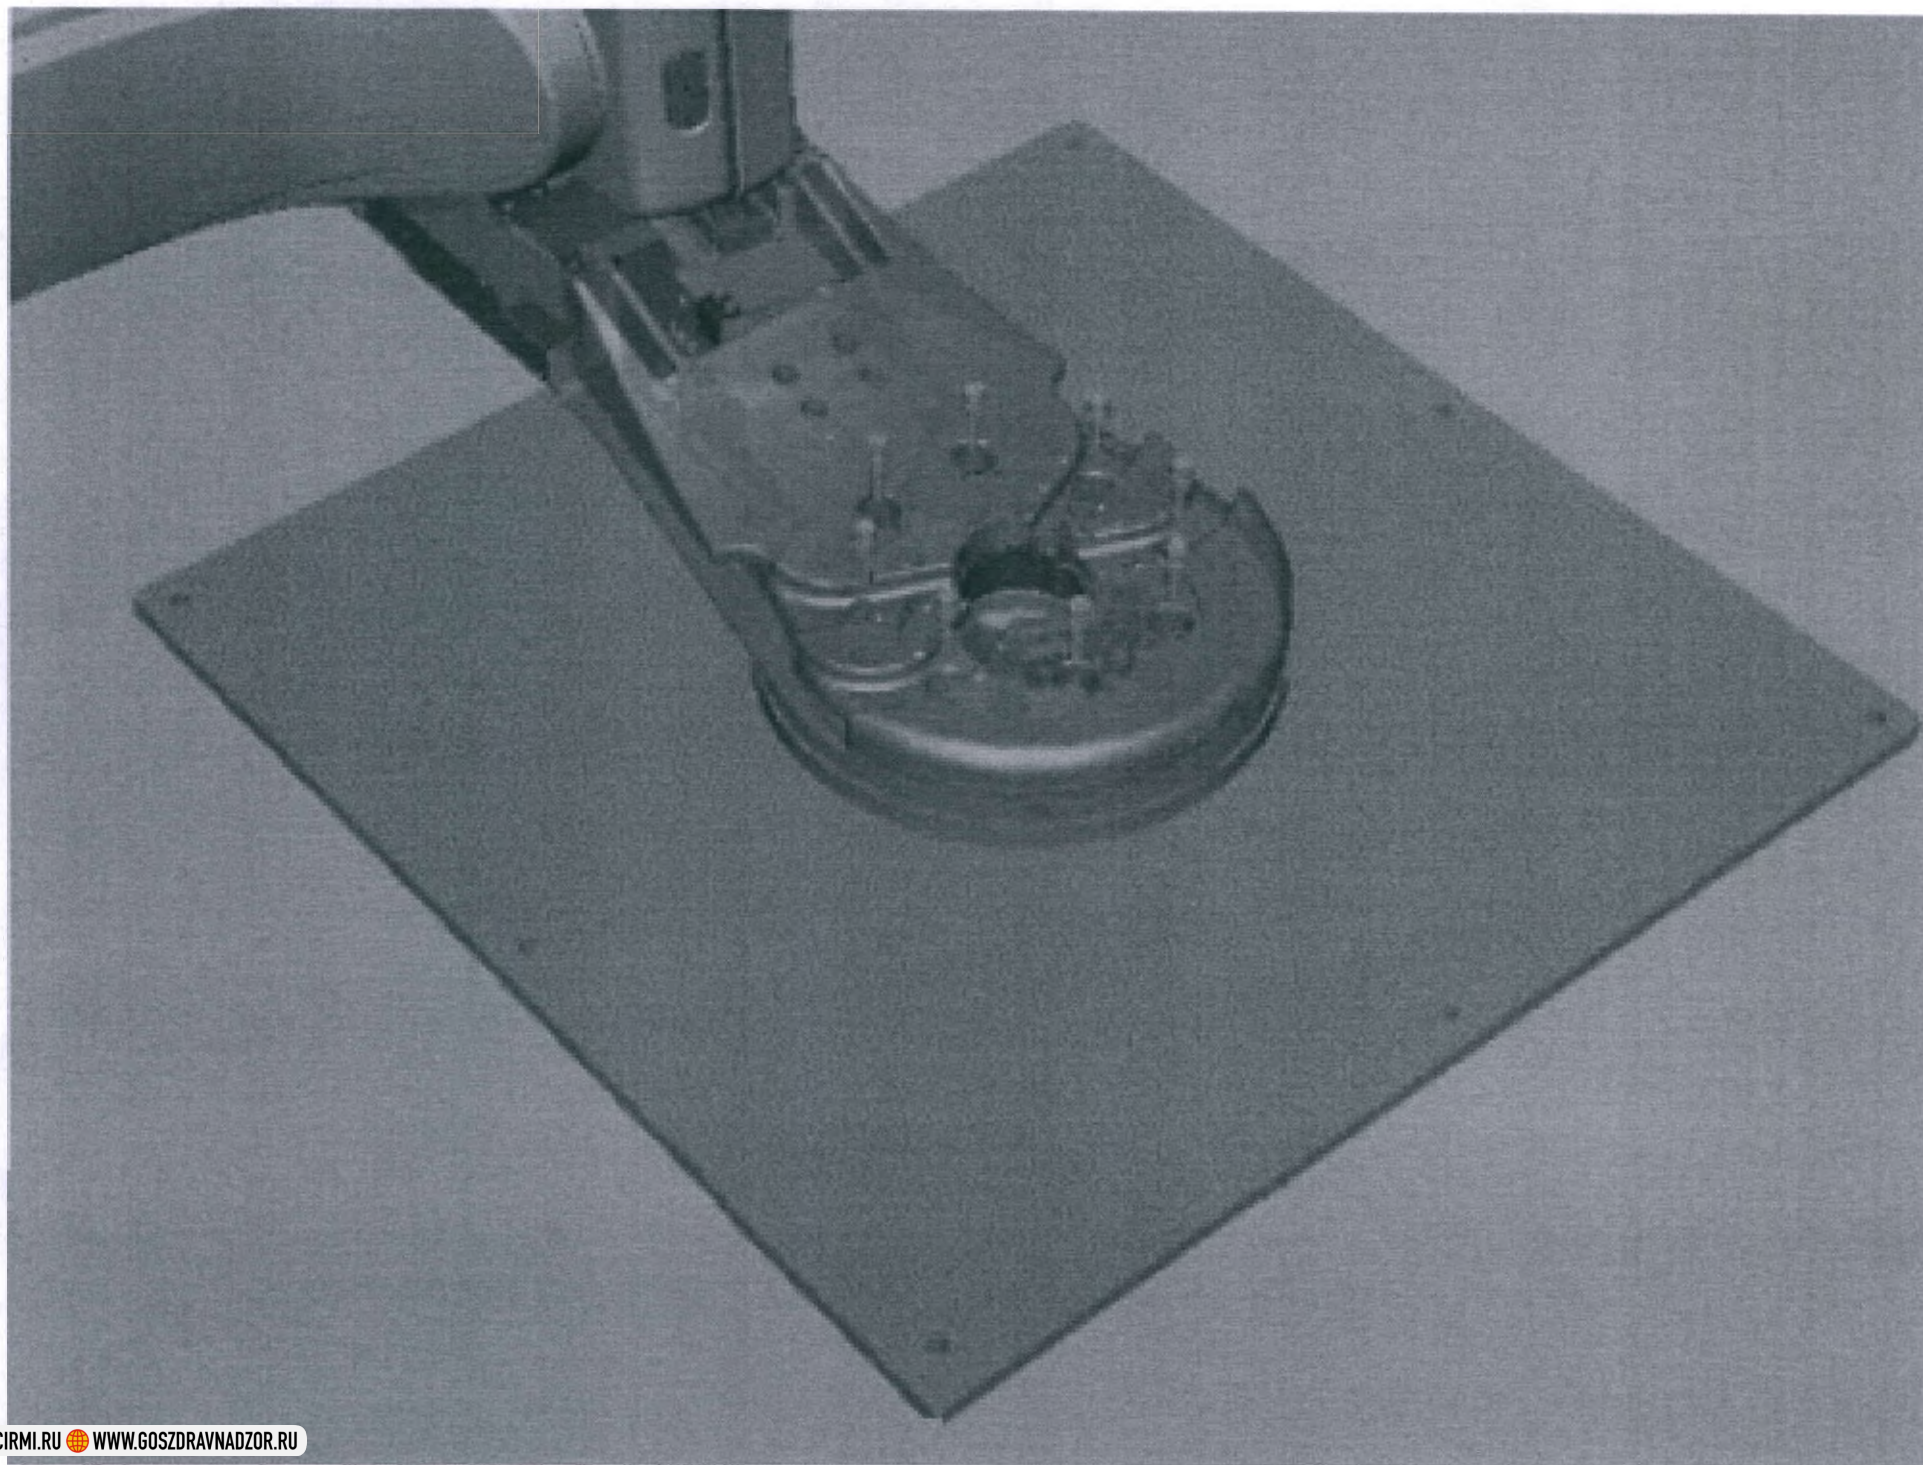

5.Опорная плита для CAS-880A, 750 мм.

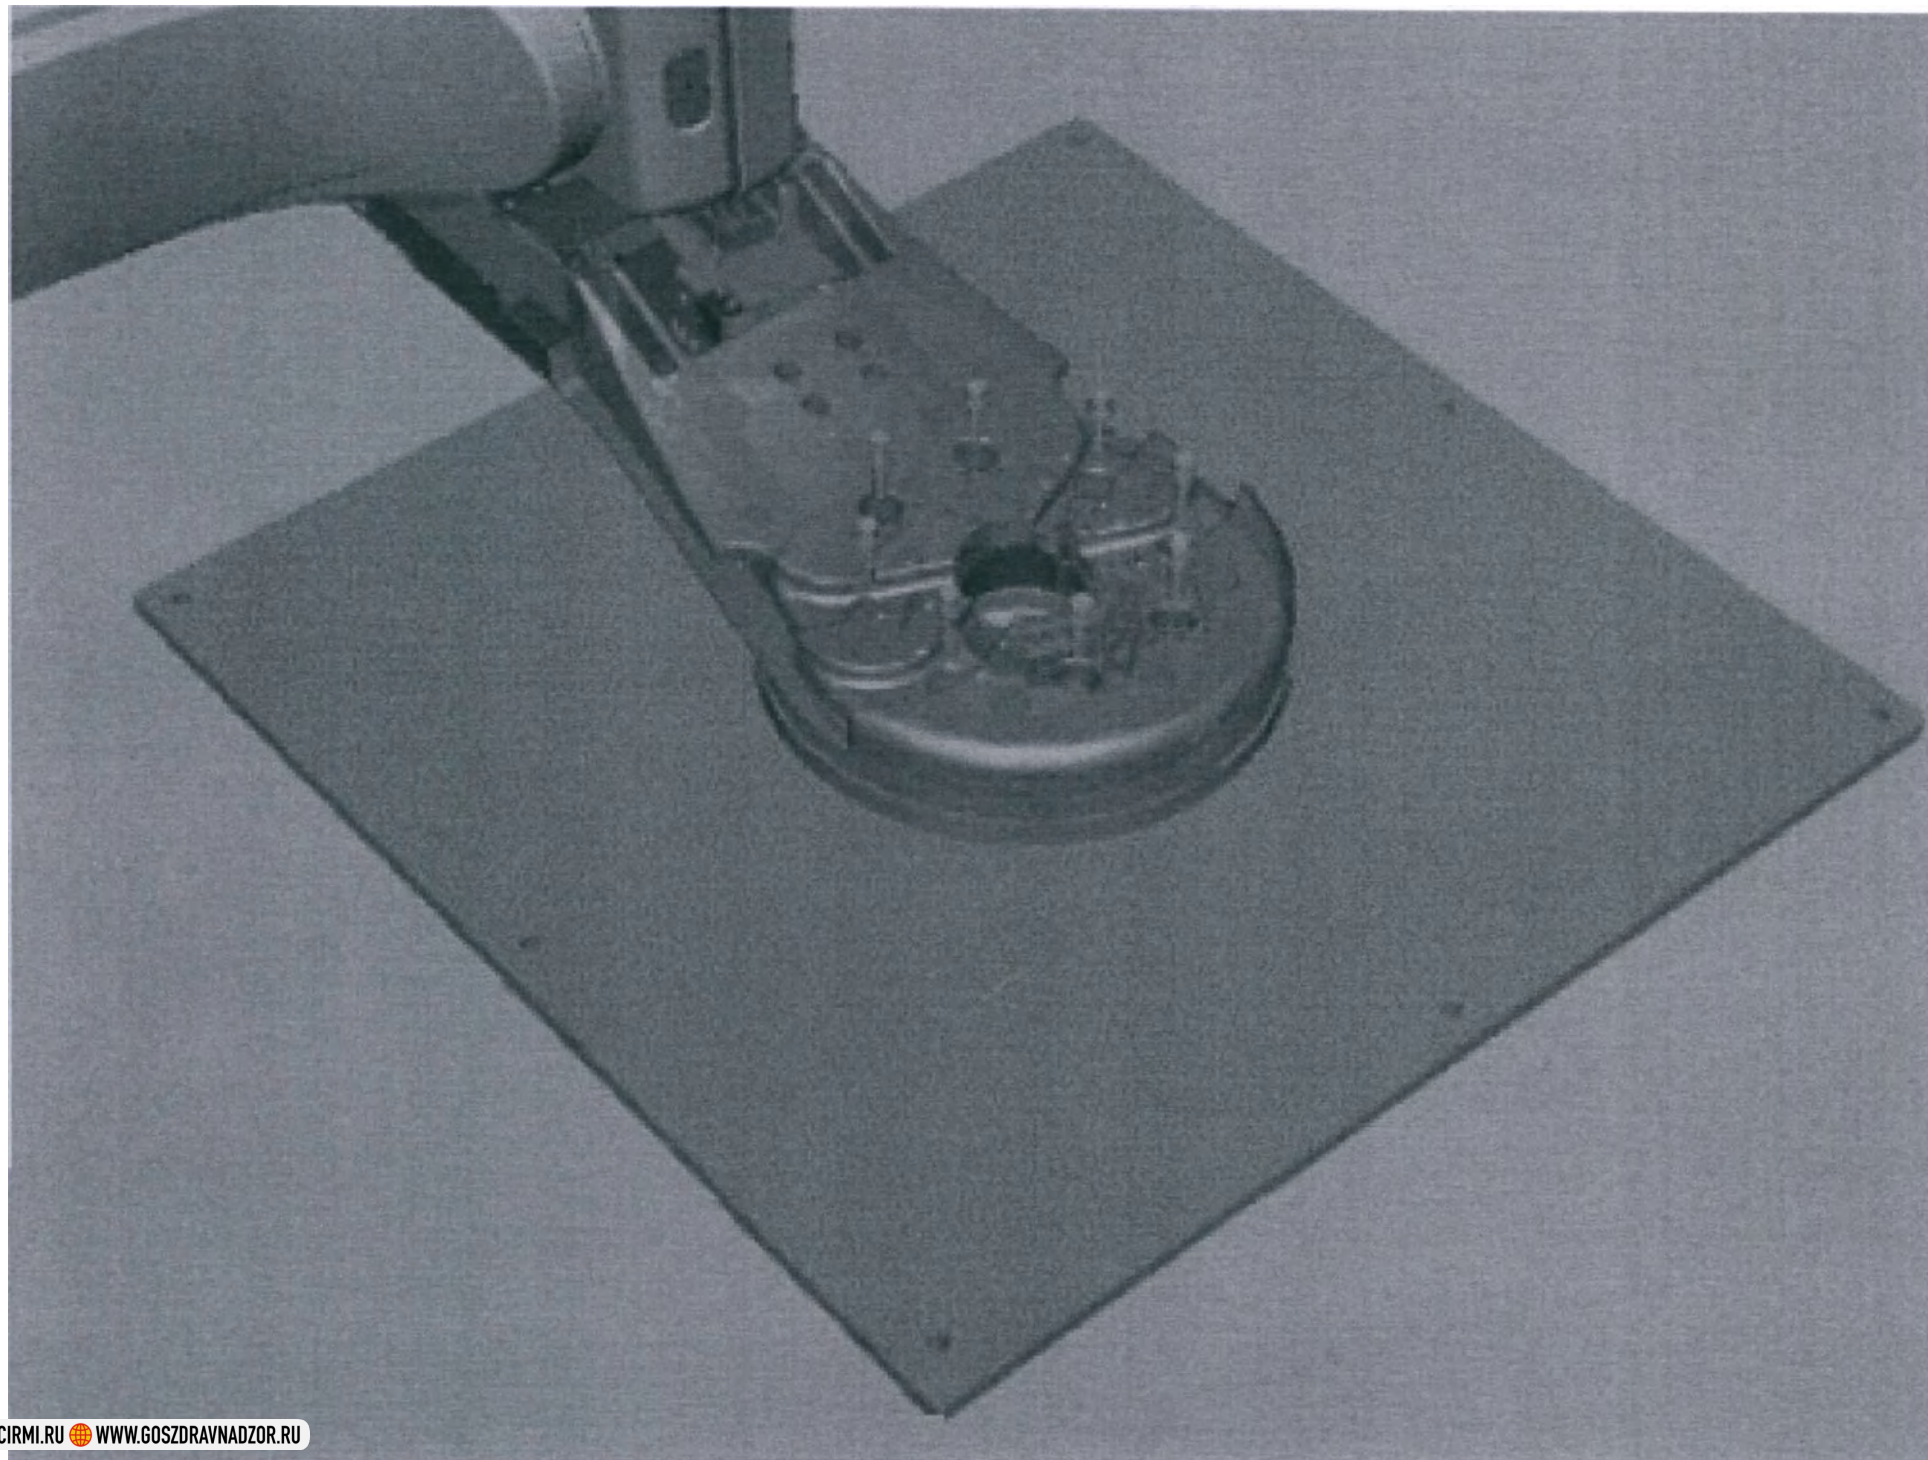

6. Переключатель управления декой стола.



7. Консоль управления декой стола (для САТ-850В).



8. Ножной переключатель (дополнительный).




9. Беспроводной ножной переключатель.



Беспроводной ножной переключатель




Сетевой адаптер

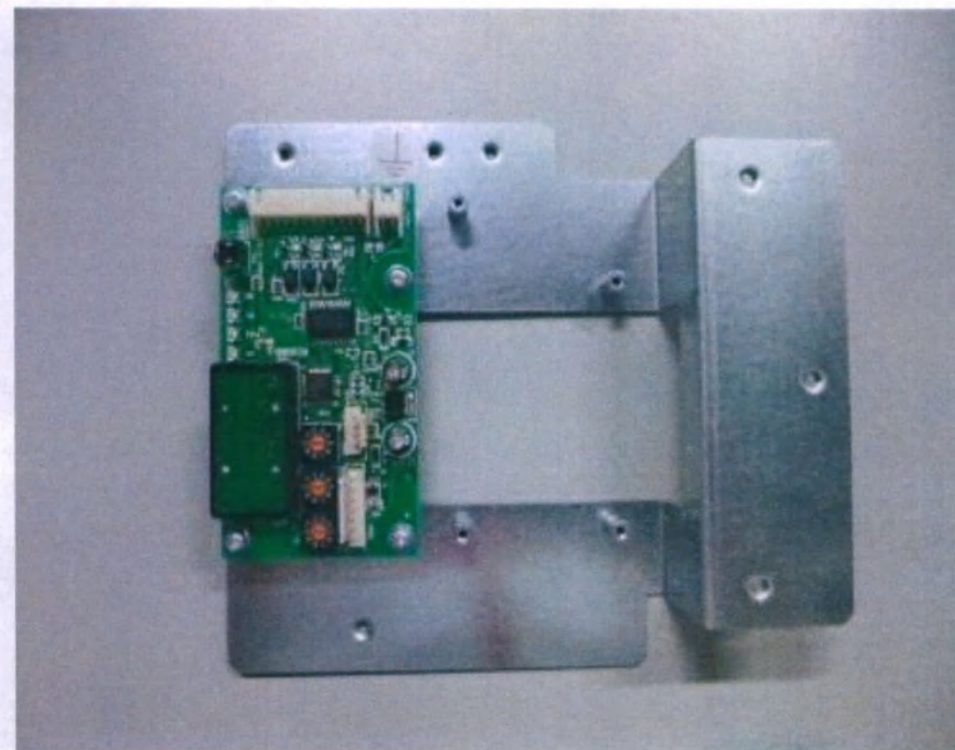


Приемник сигнала


10. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-850В).

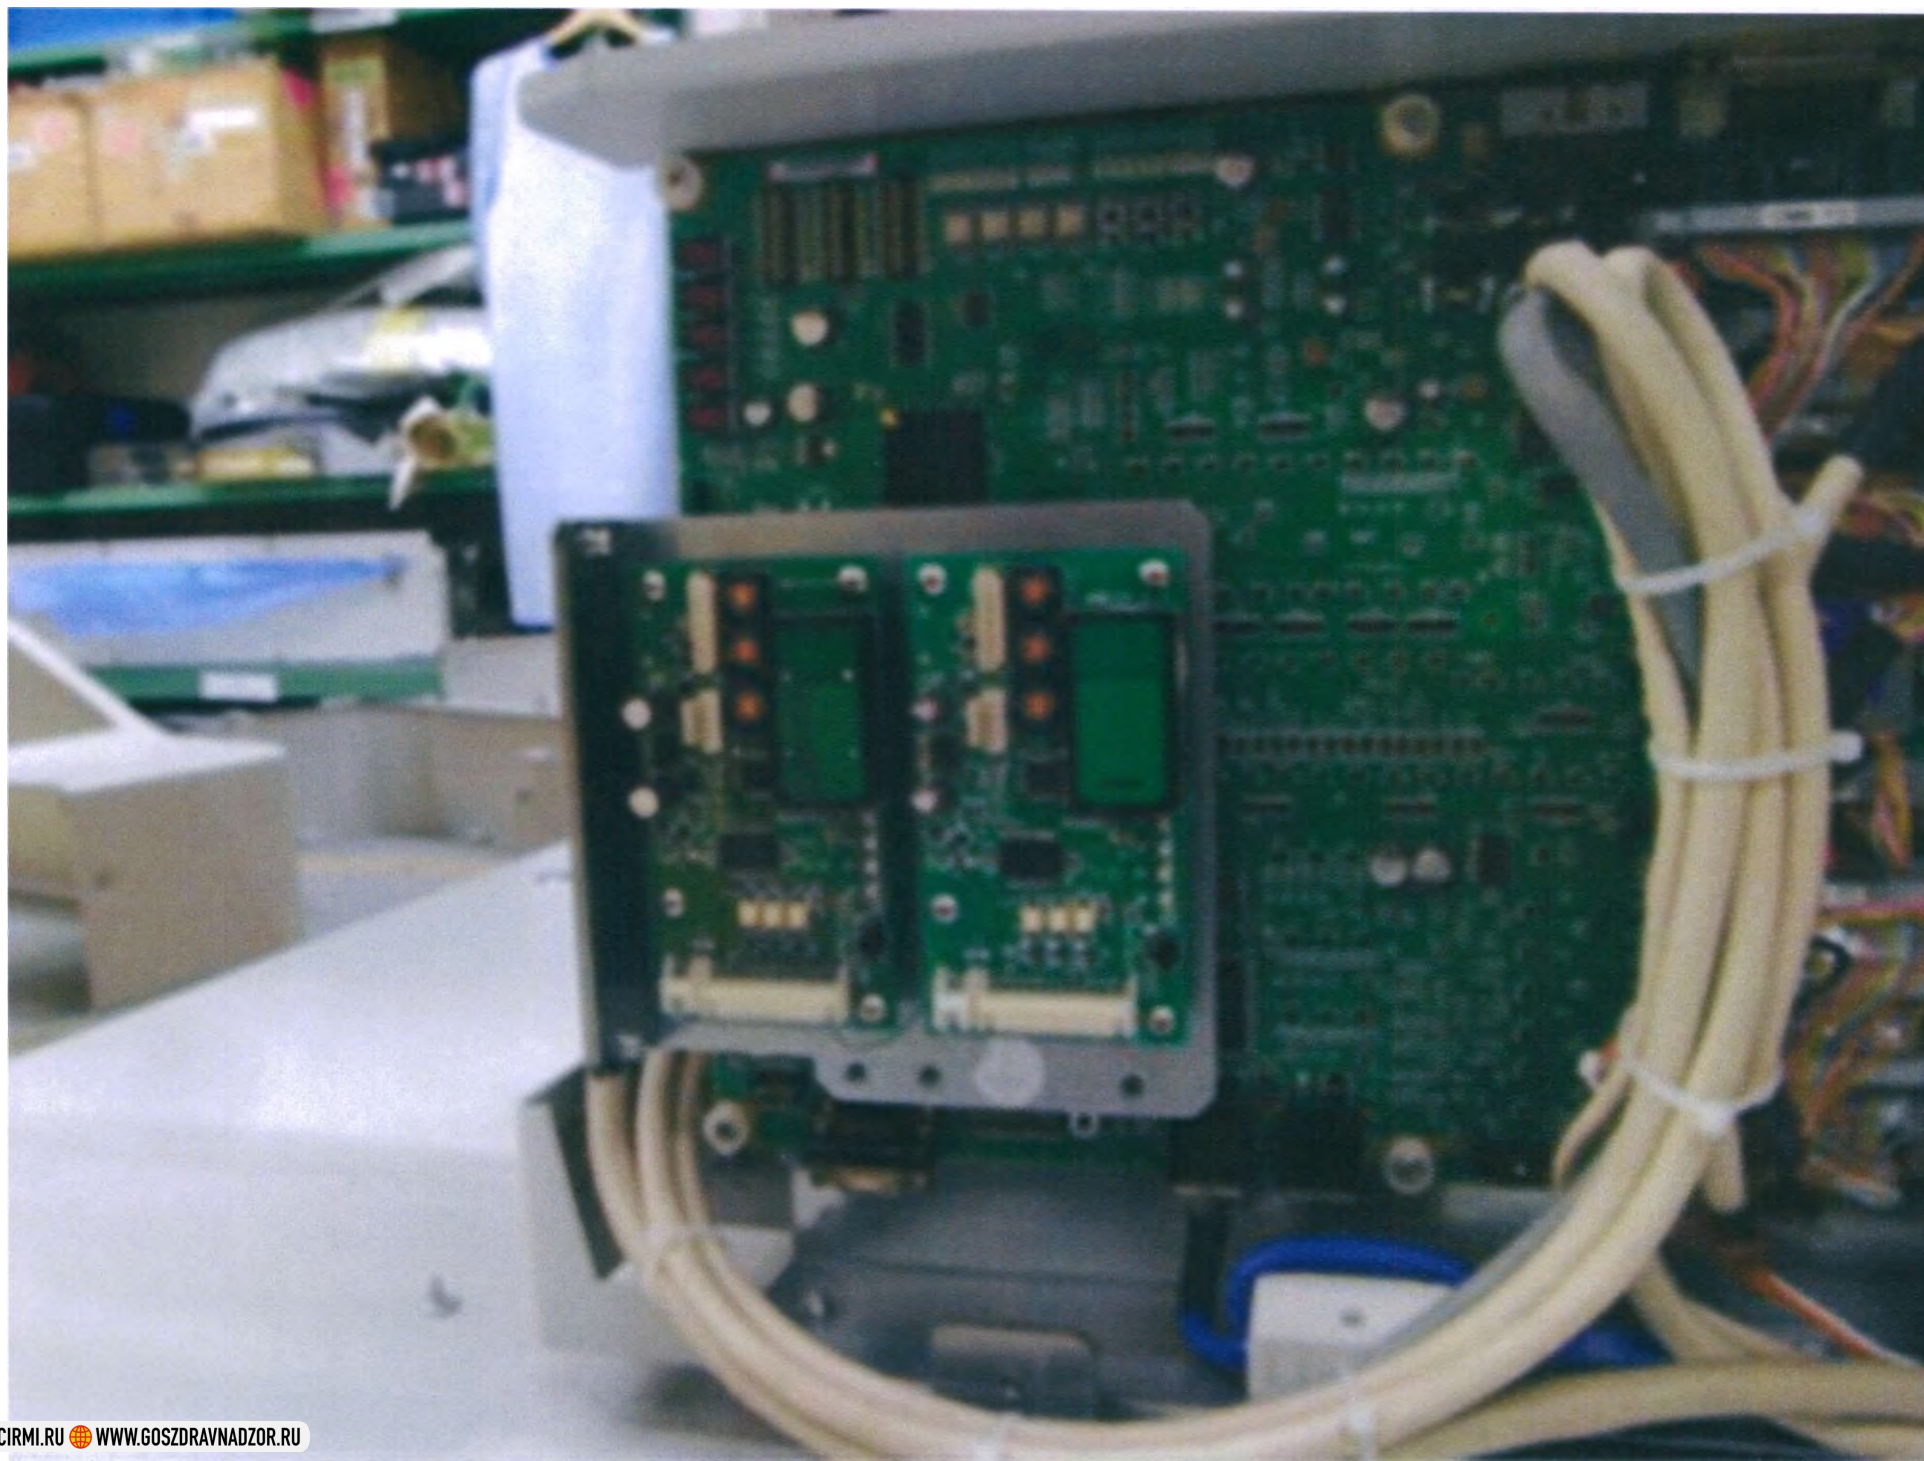


11. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-880В).

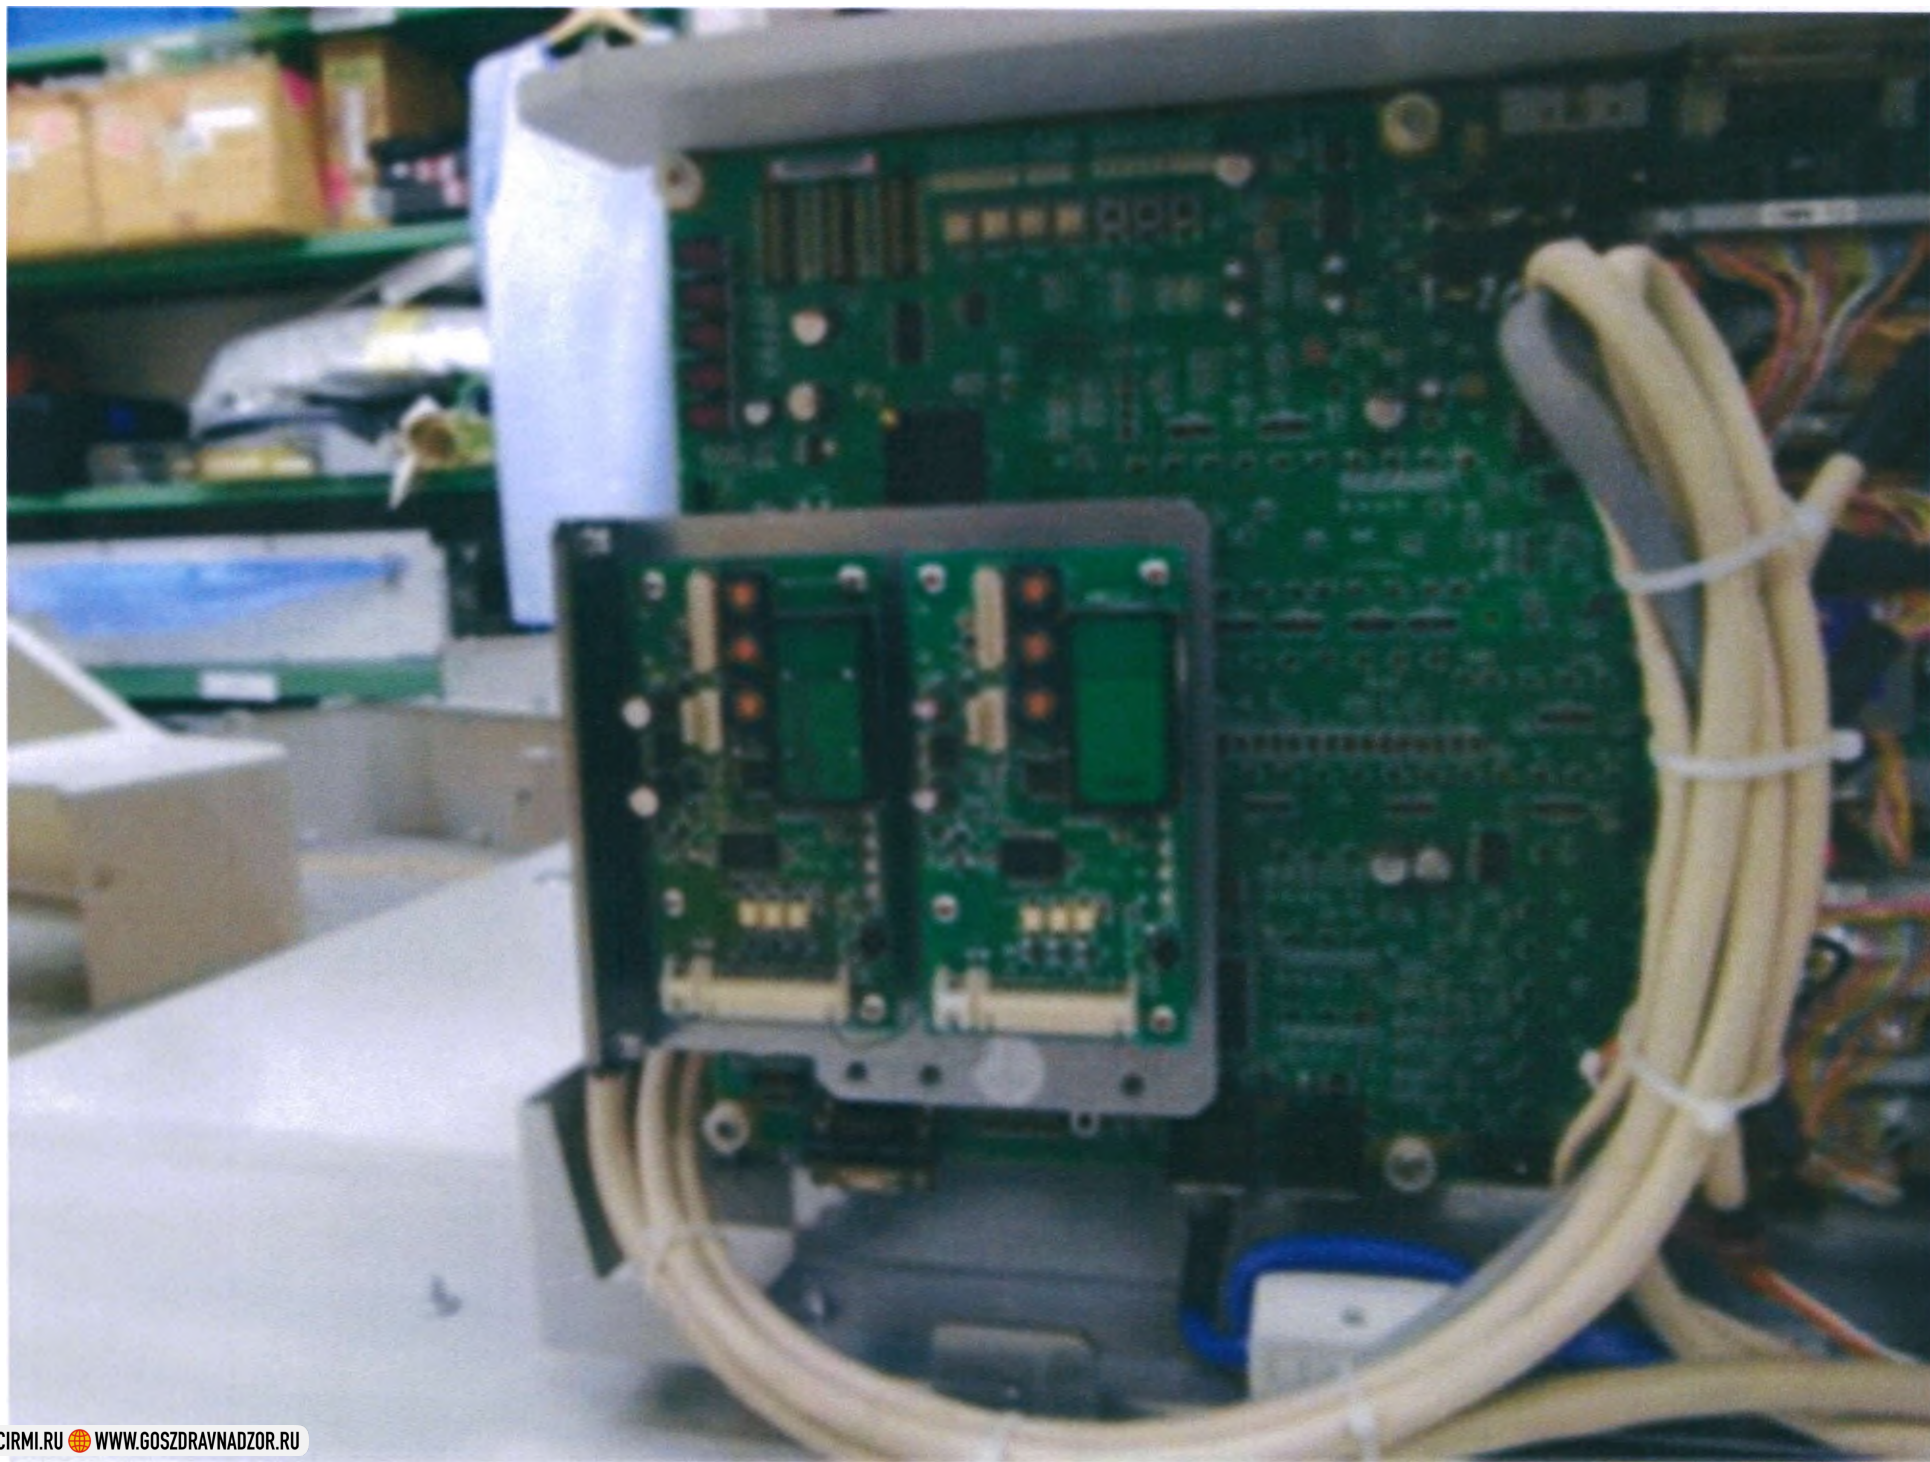

12. Подлокотник для обеих рук.

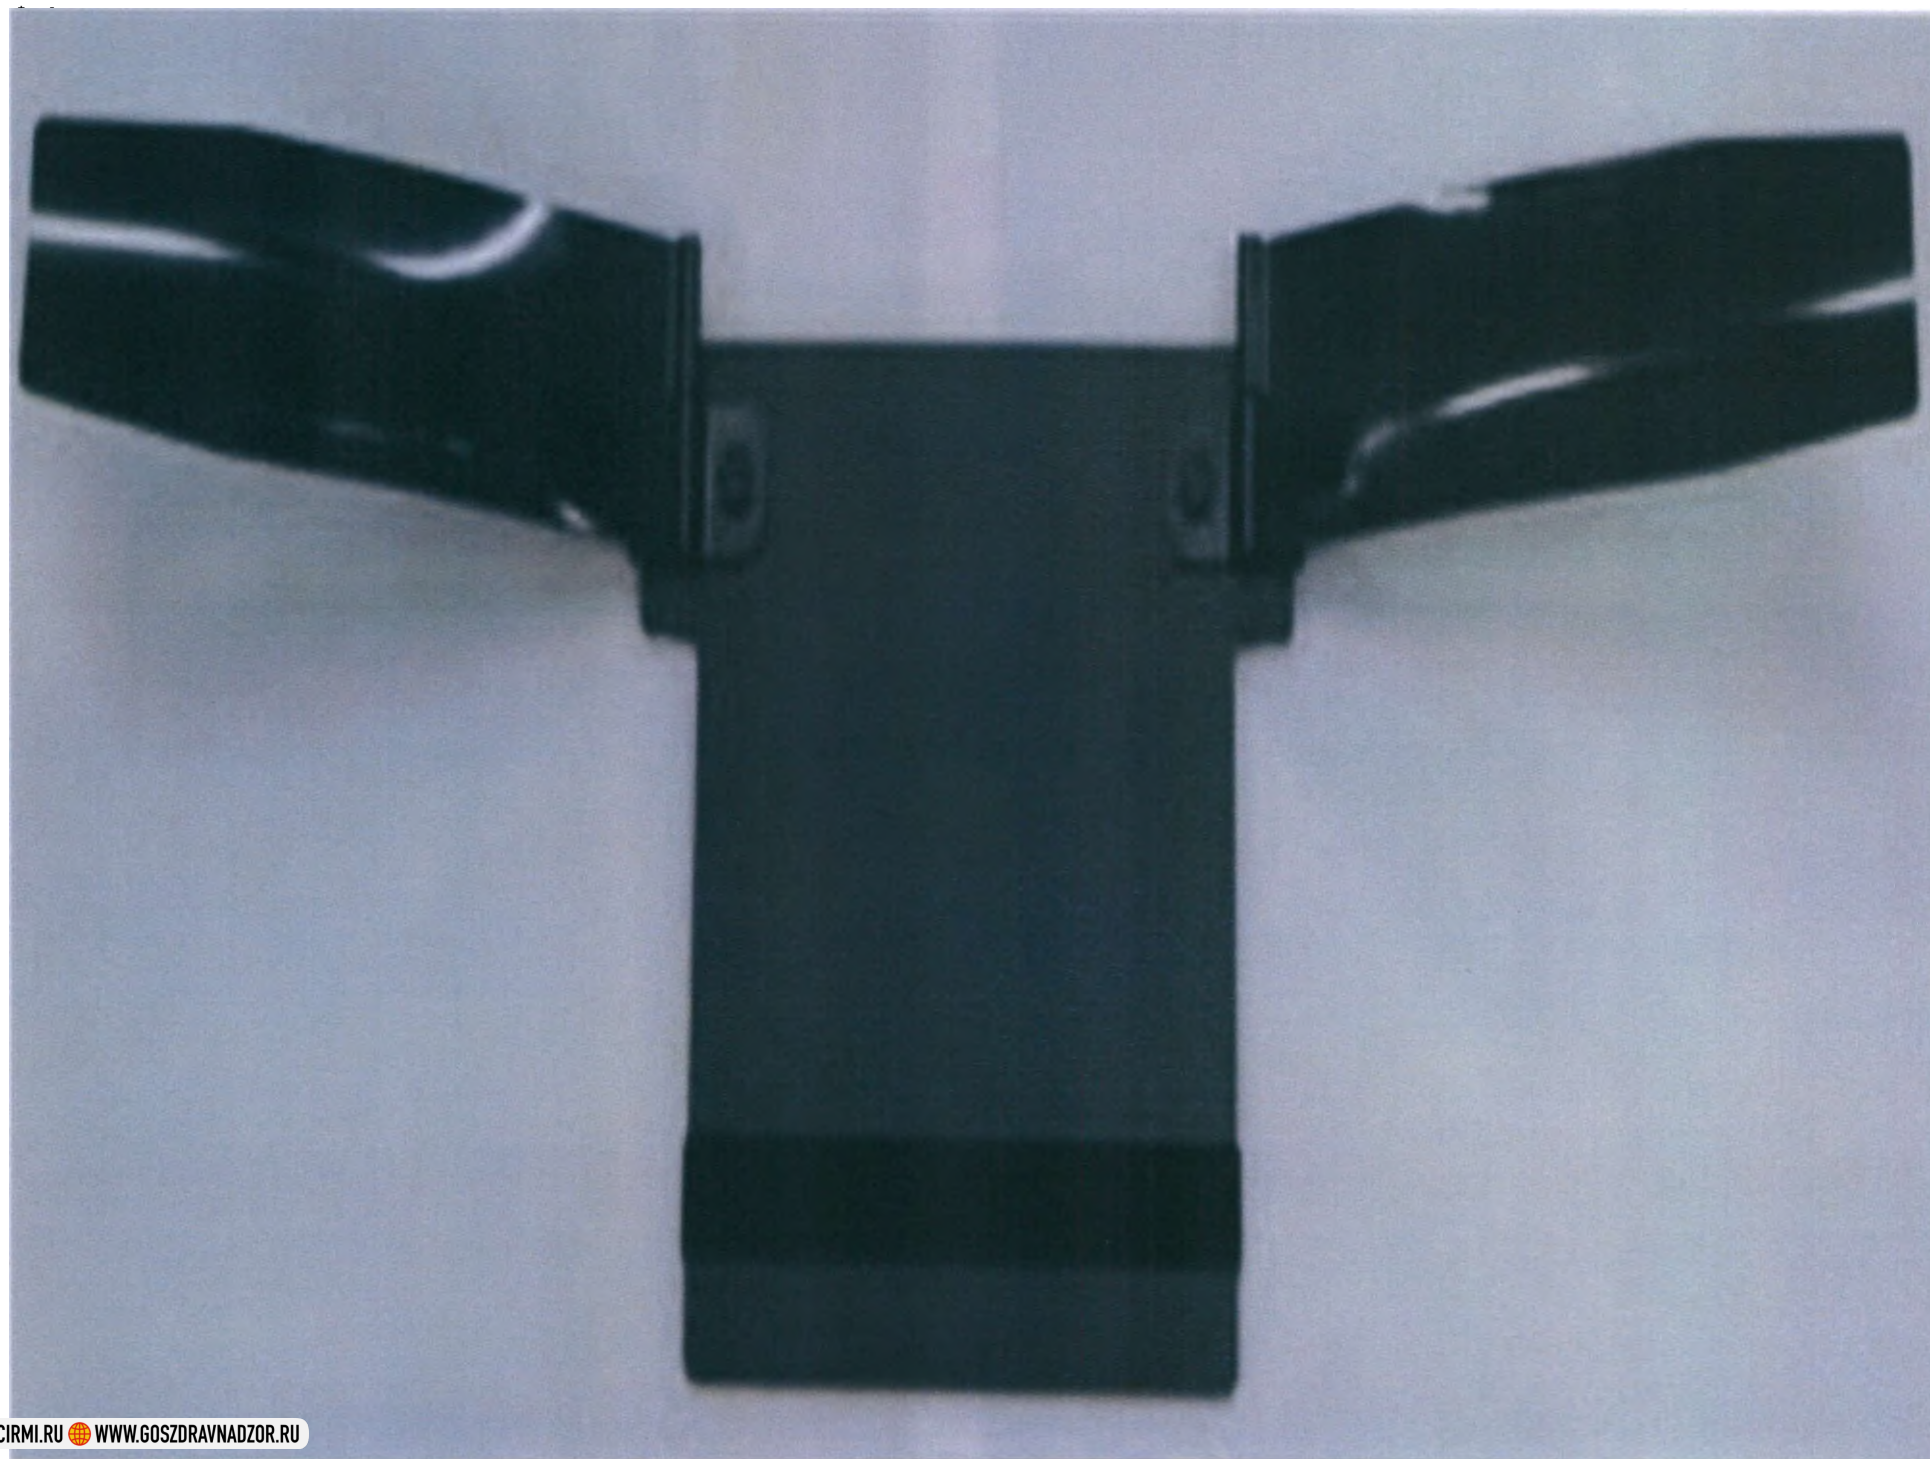


13. Подлокотник для одной руки (для САТ-880В).

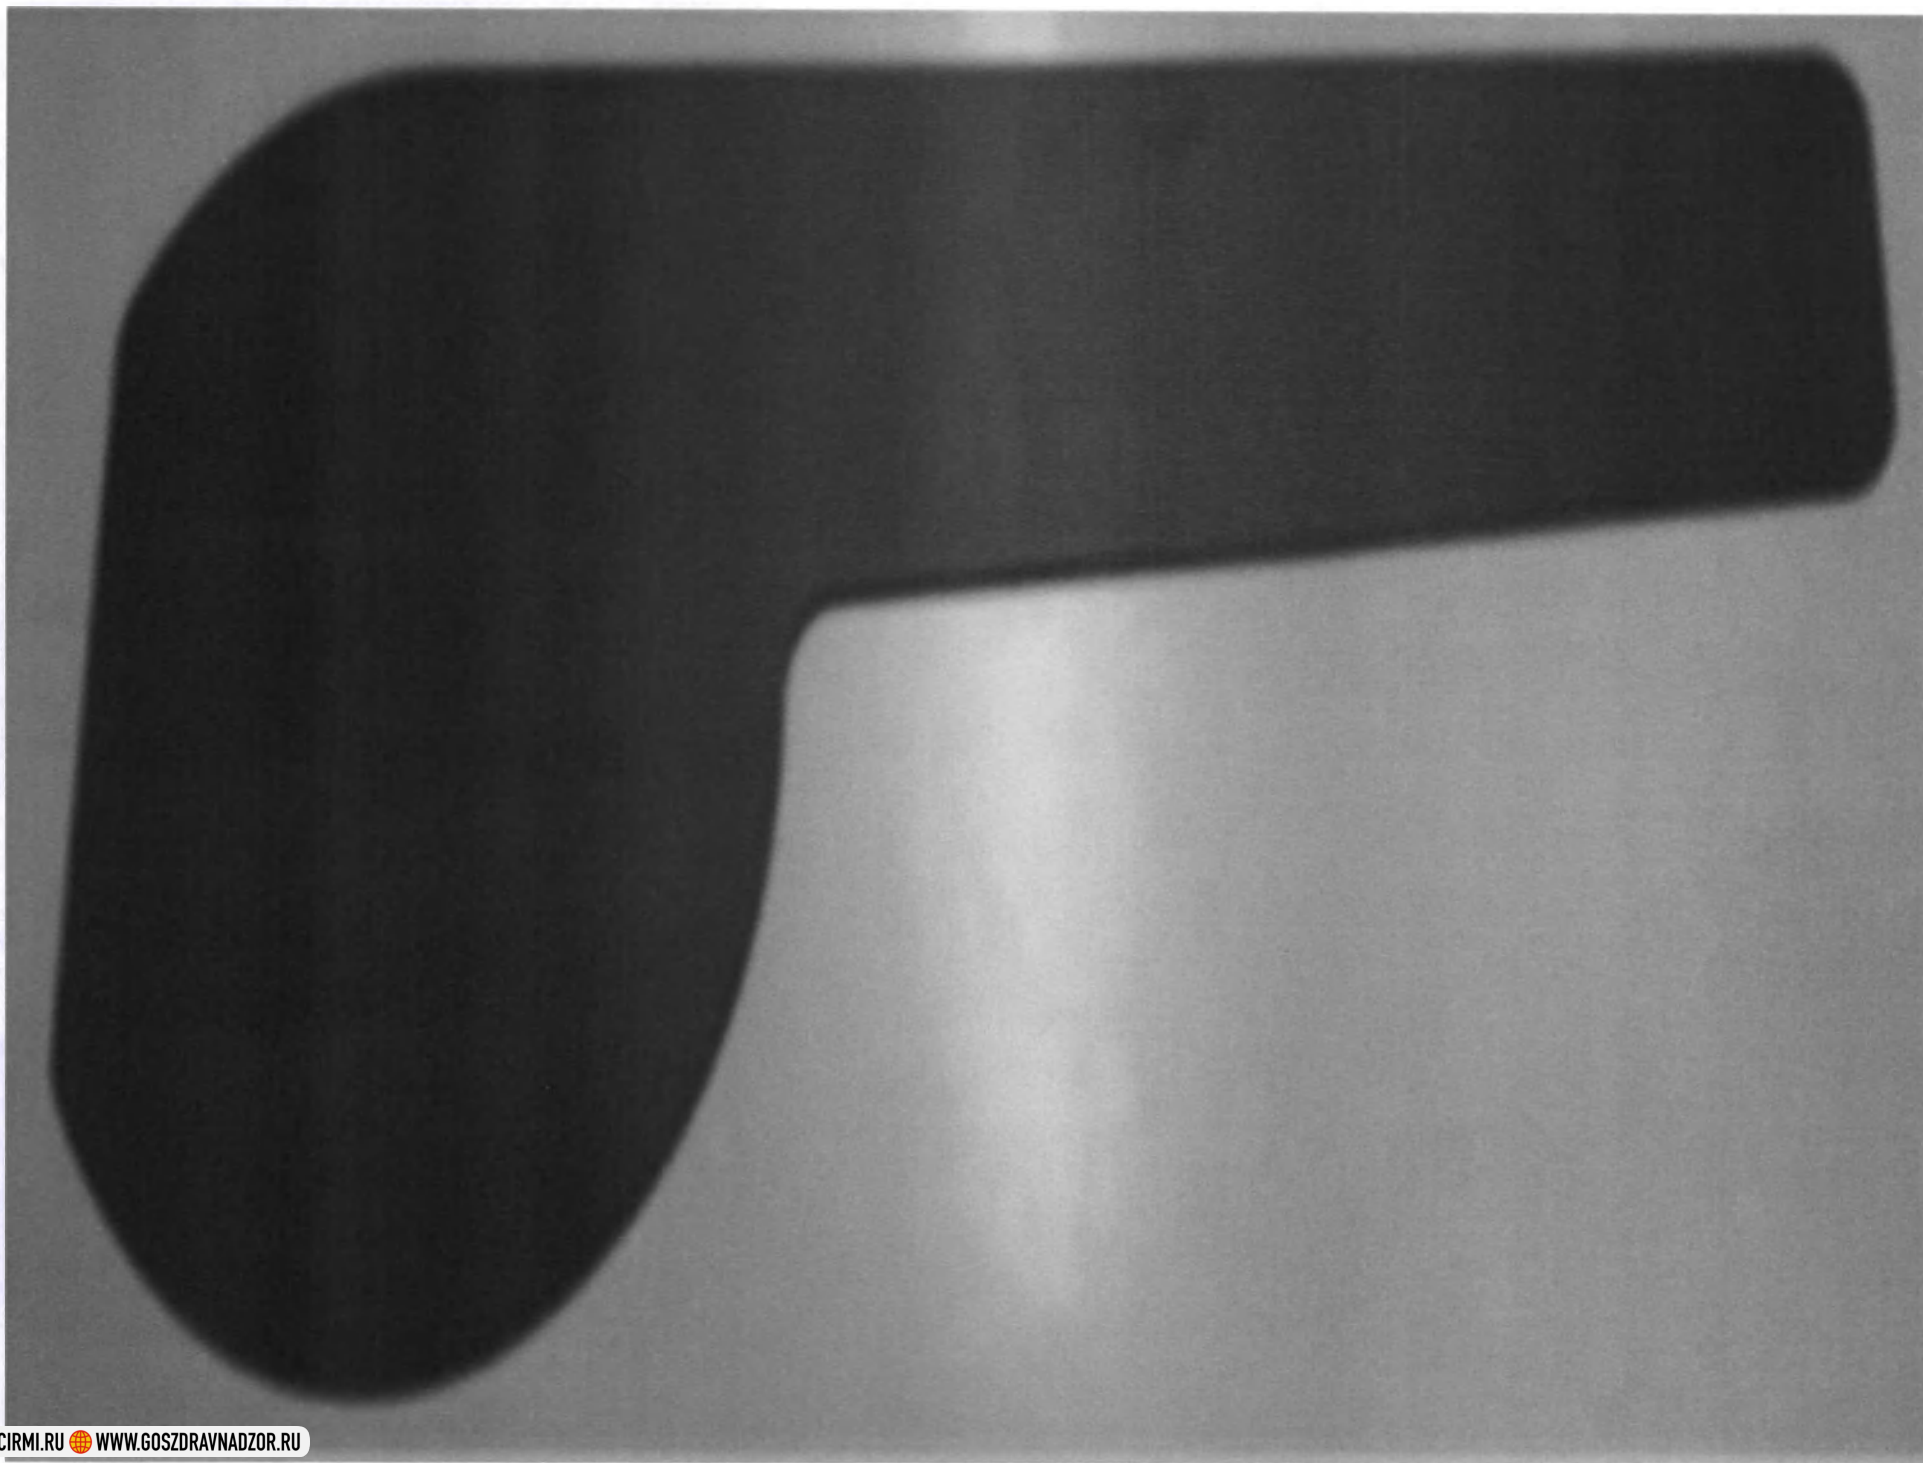

14. Держатель для рук (для САТ-850В).




15. Держатель для рук (для САТ-880В).

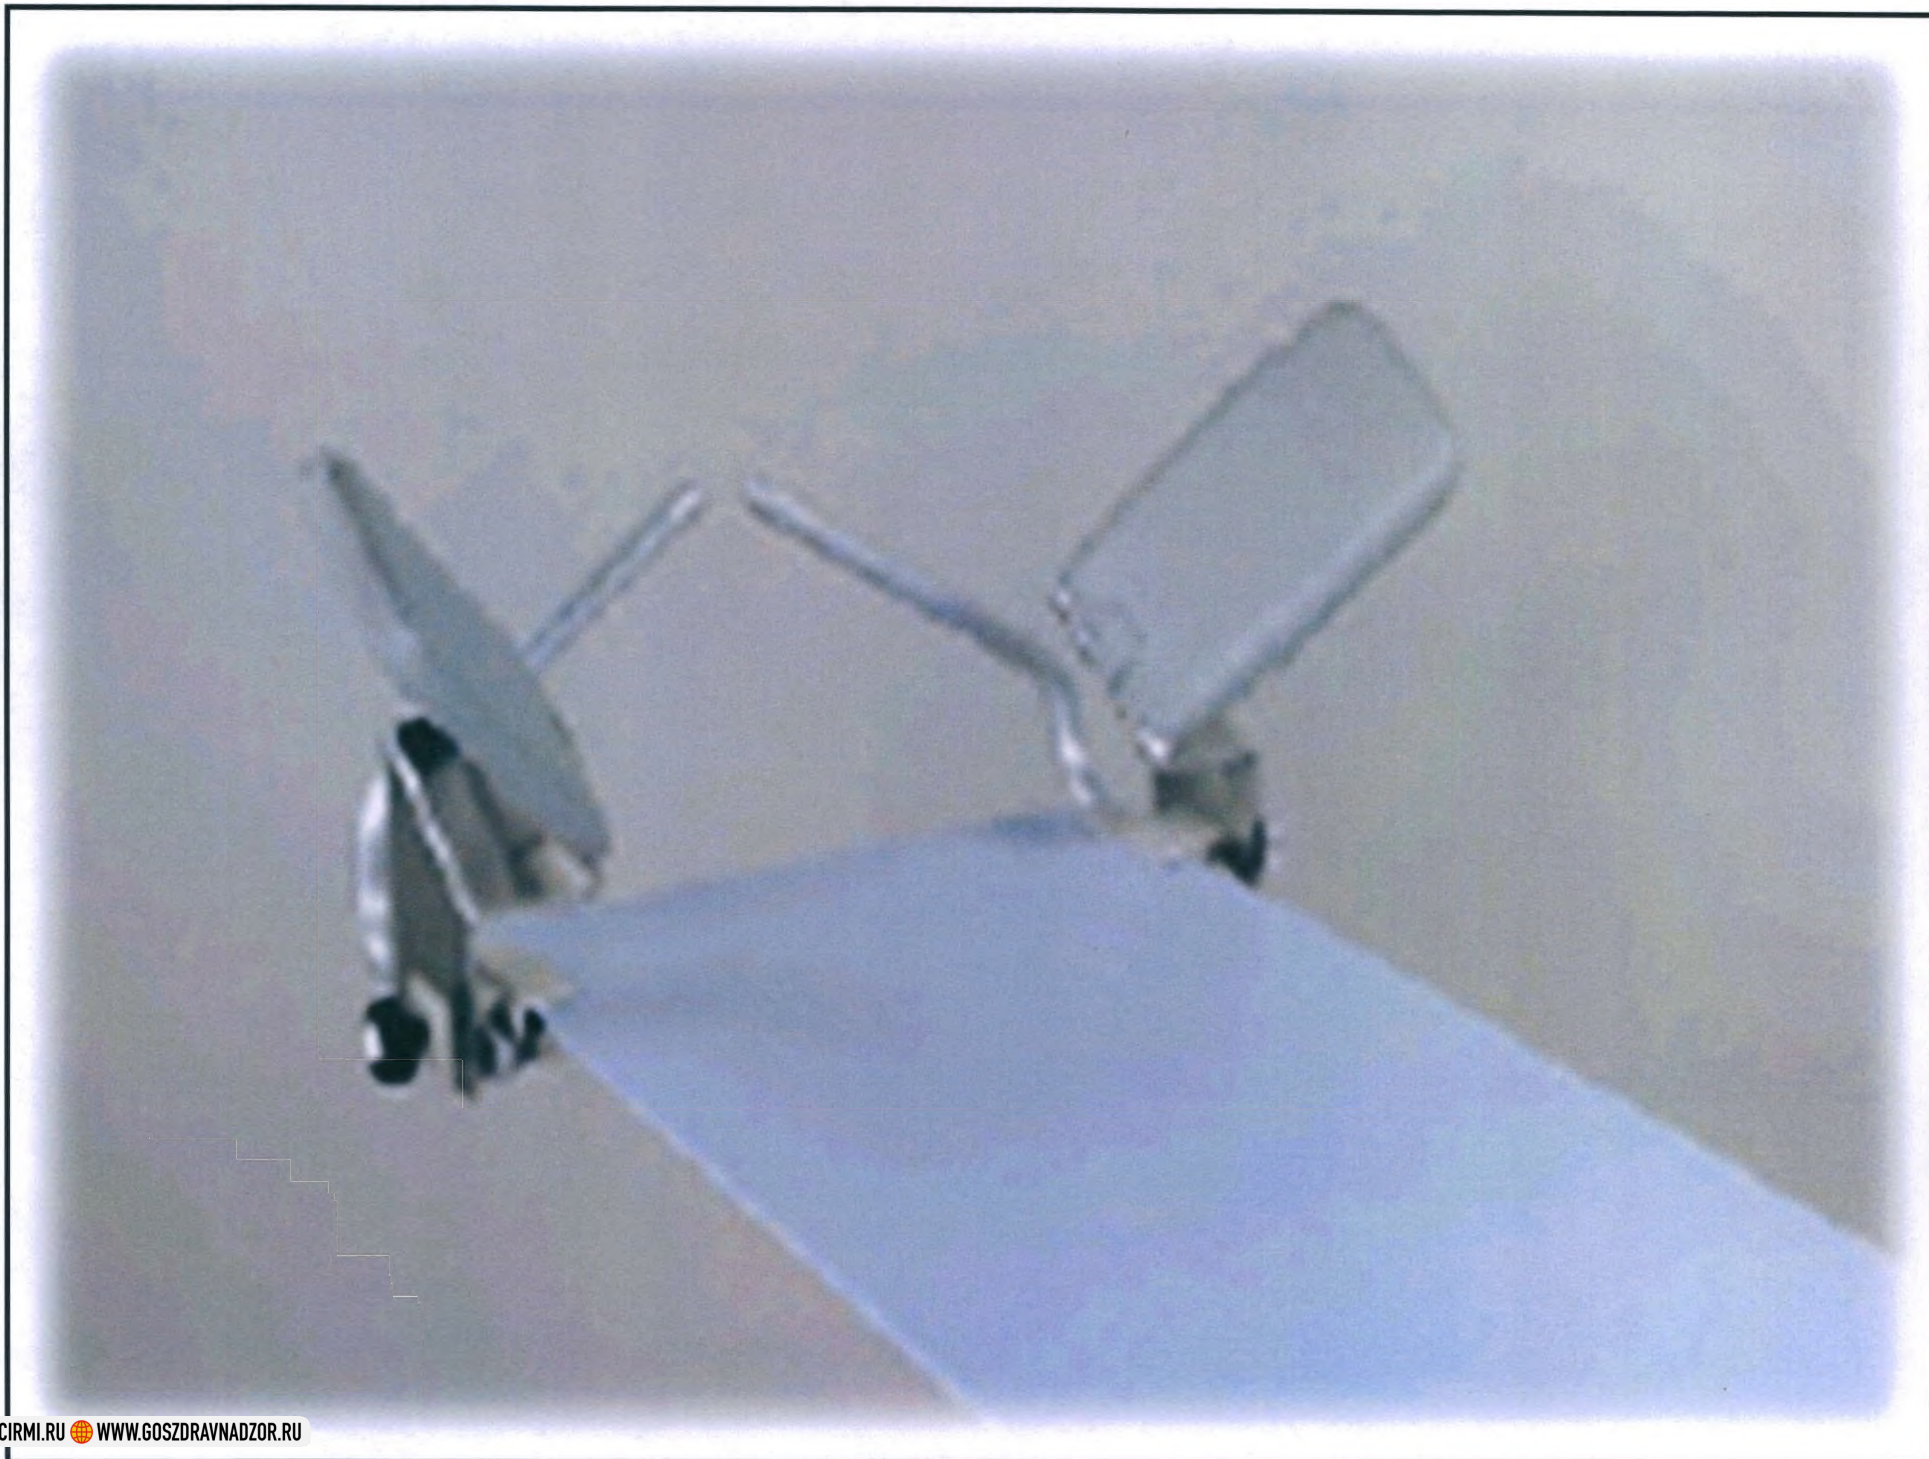


16. Нарукавник (панель для защиты рук).



17. Дополнительная направляющая деки стола (для САТ-880В).

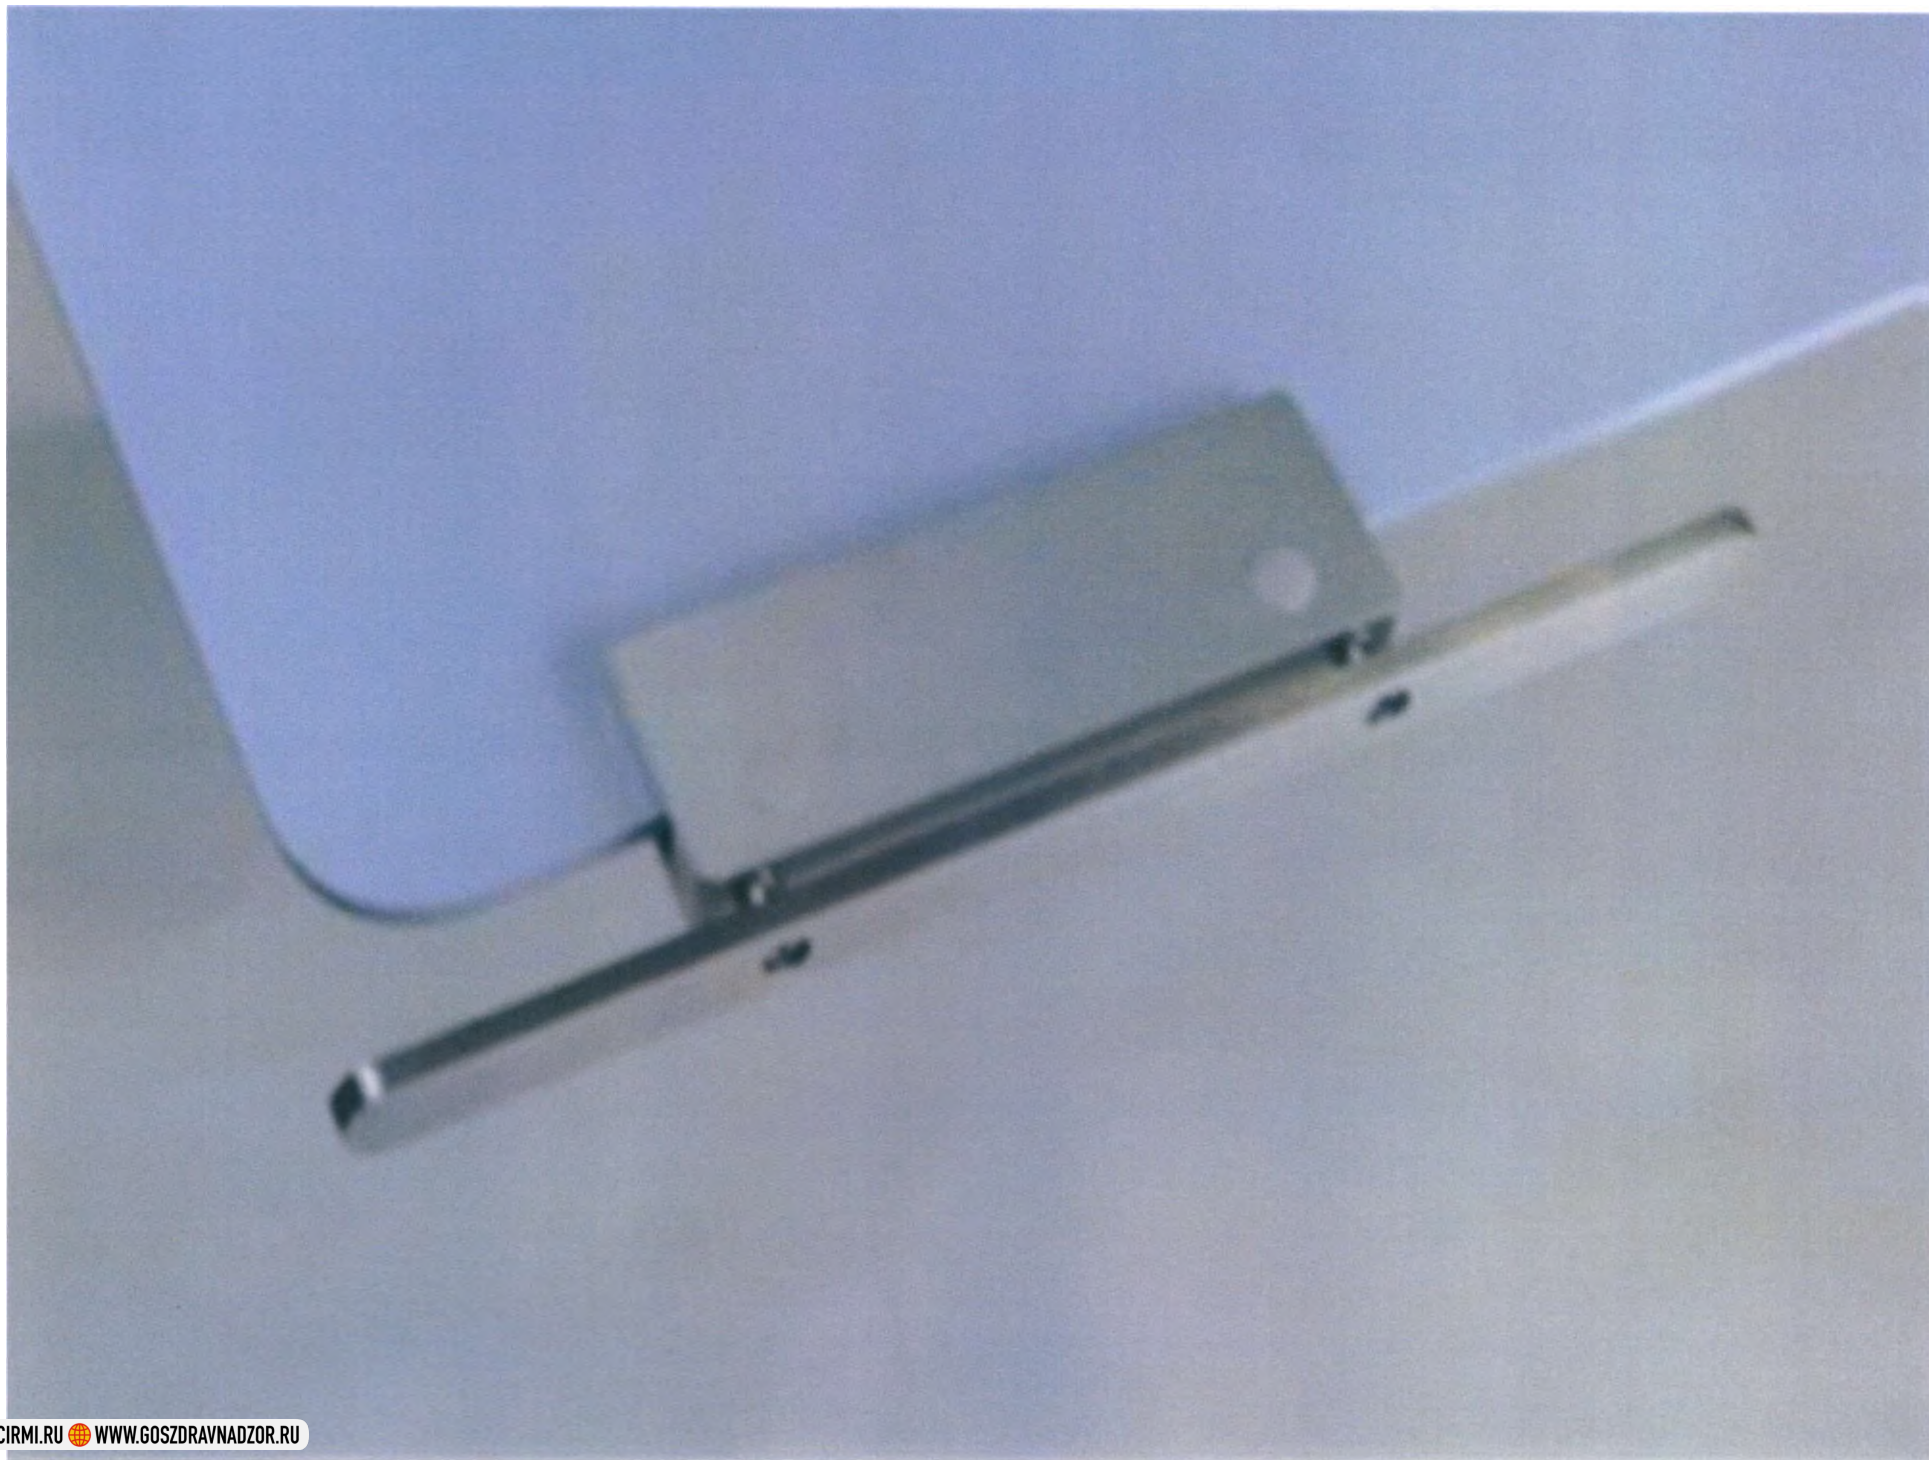



18. Держатель простыни (для САТ-880В).

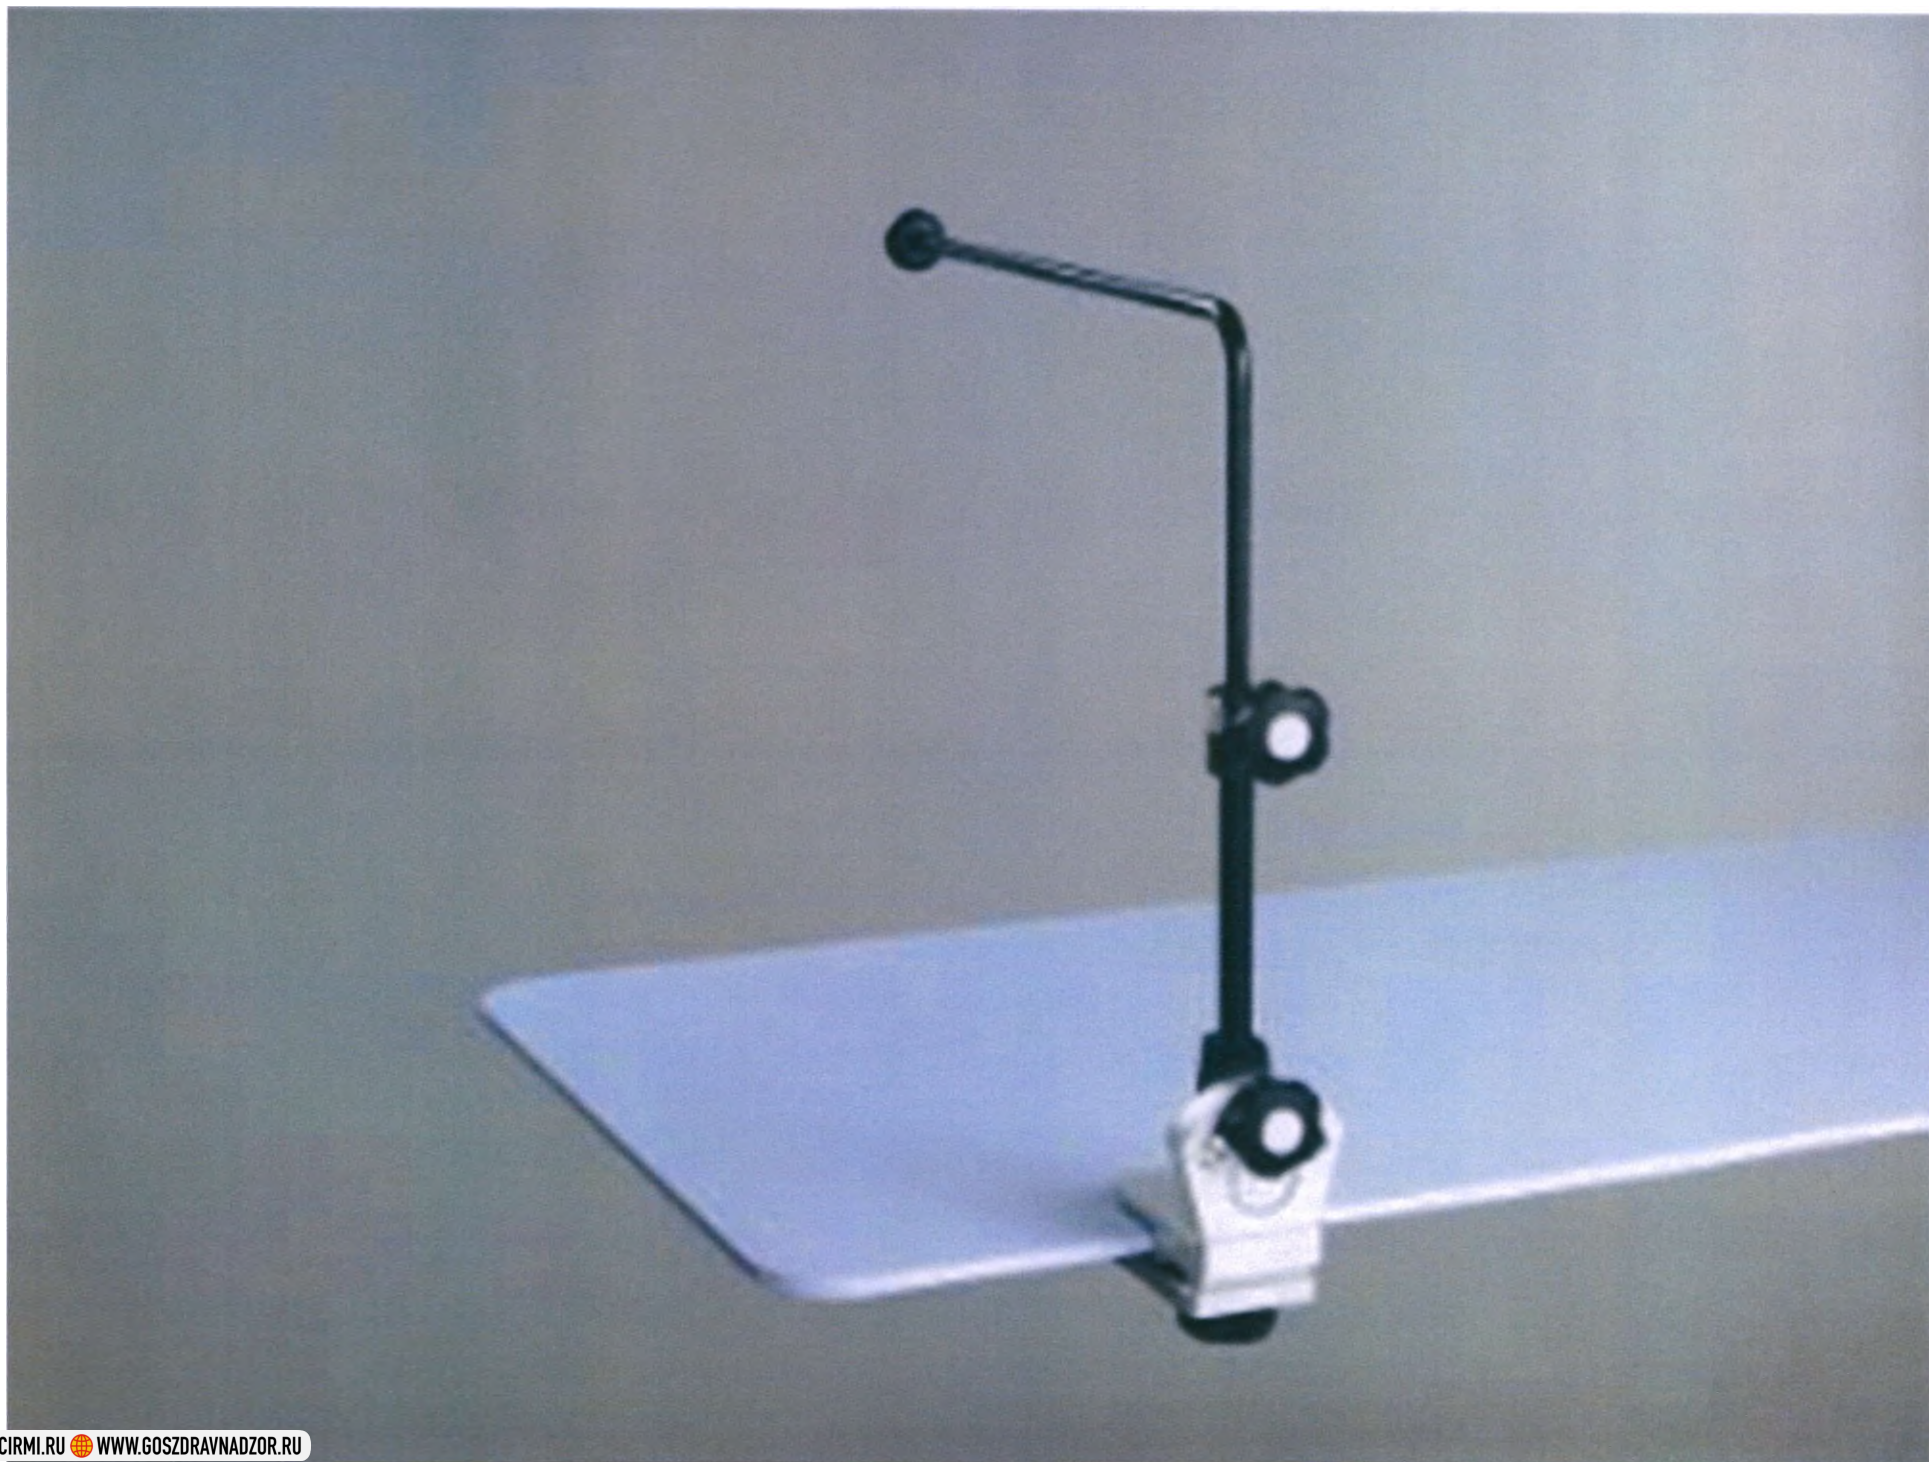


19. Опорная плита для стола.

19

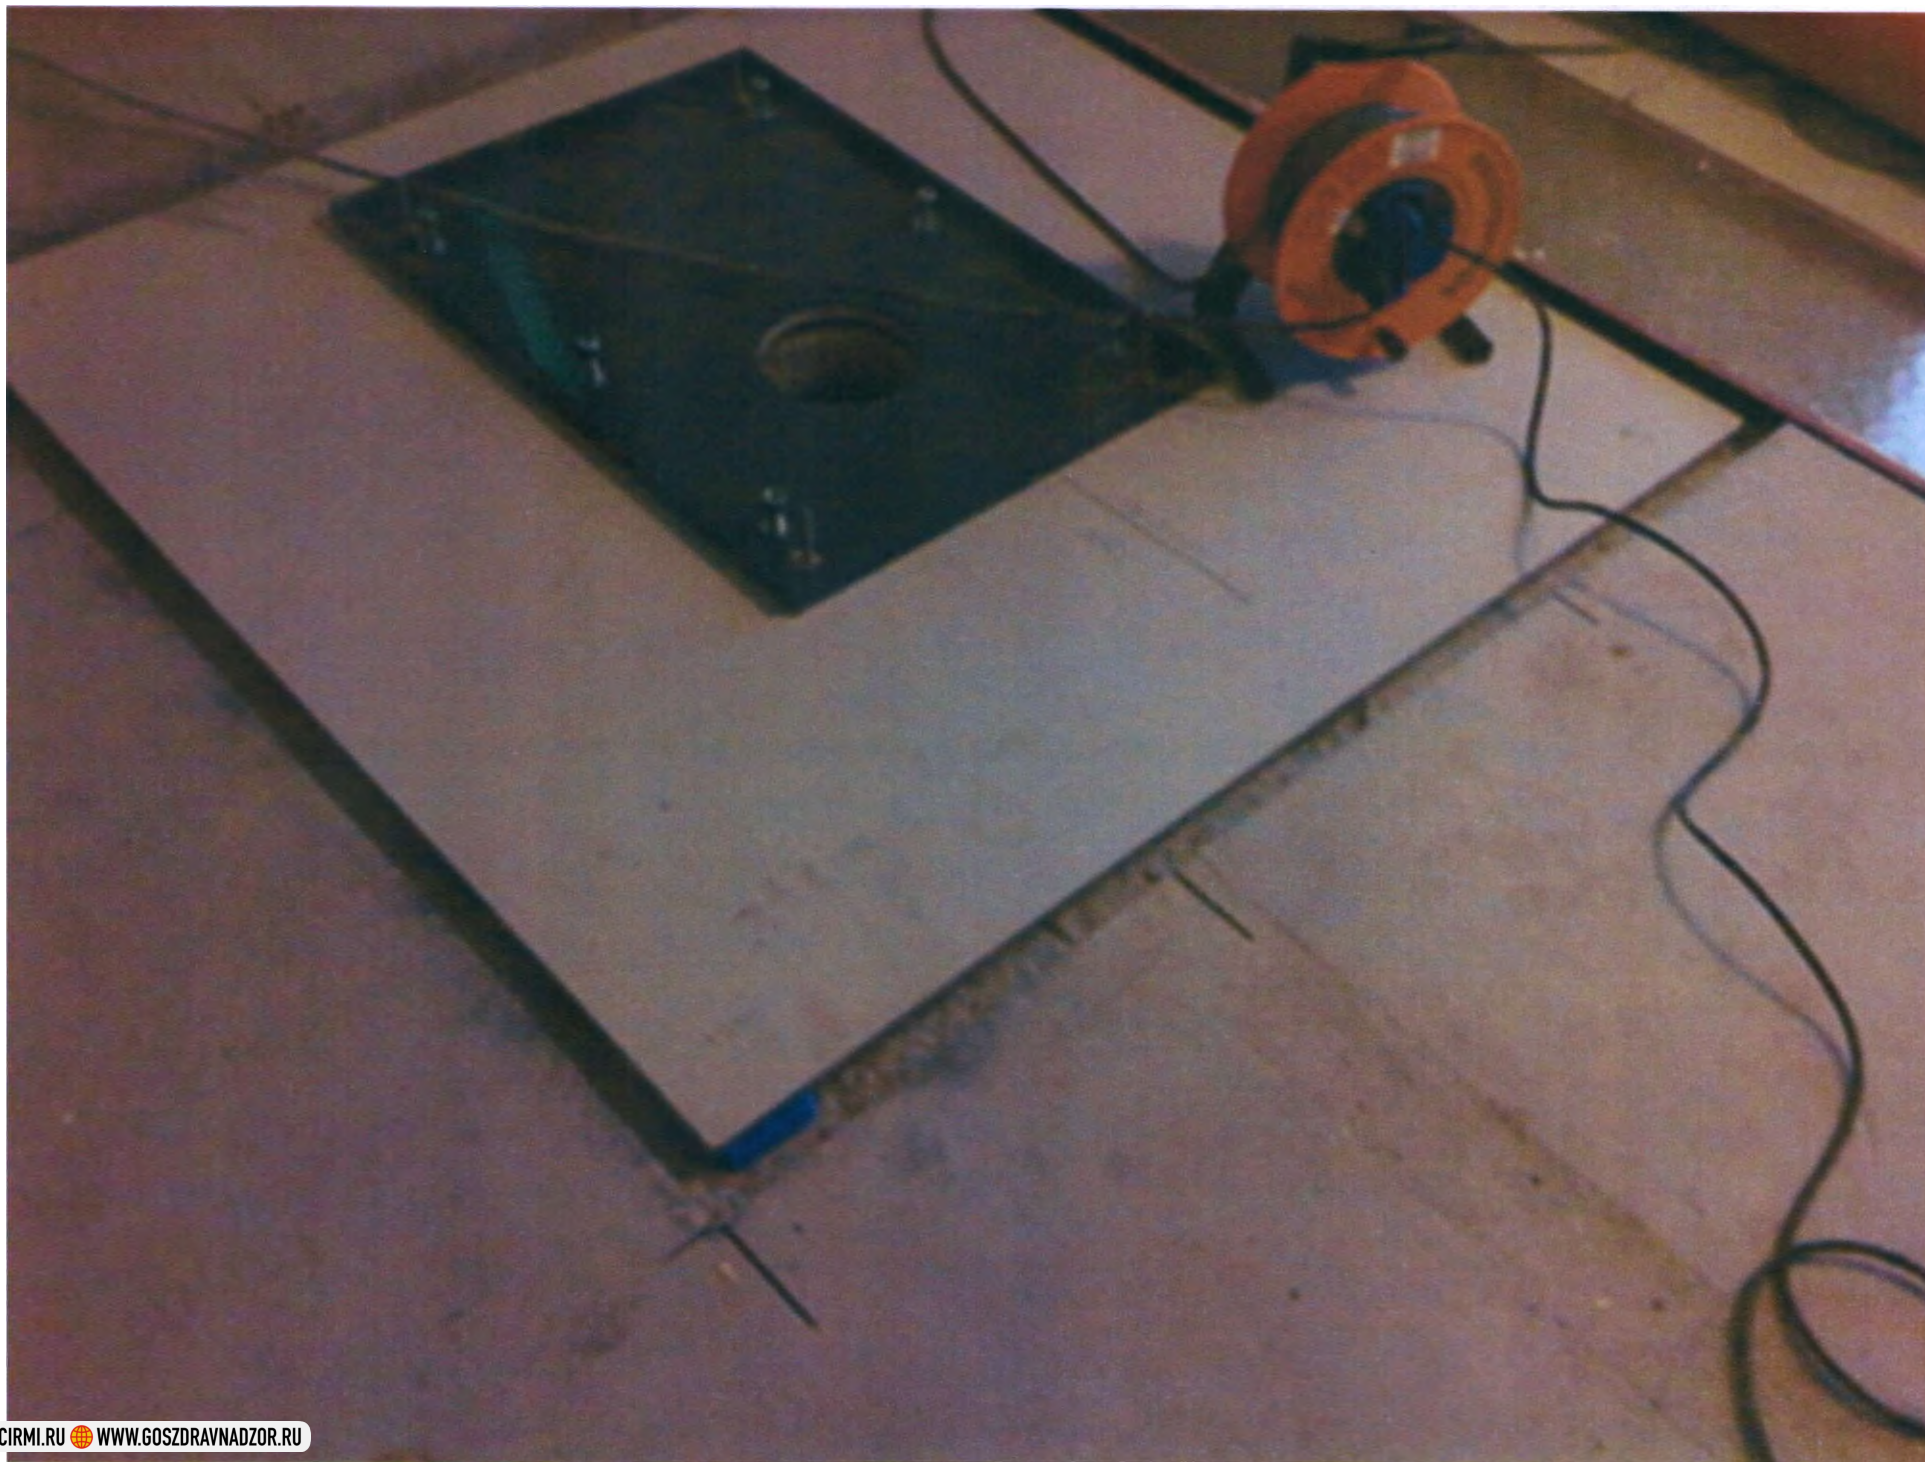

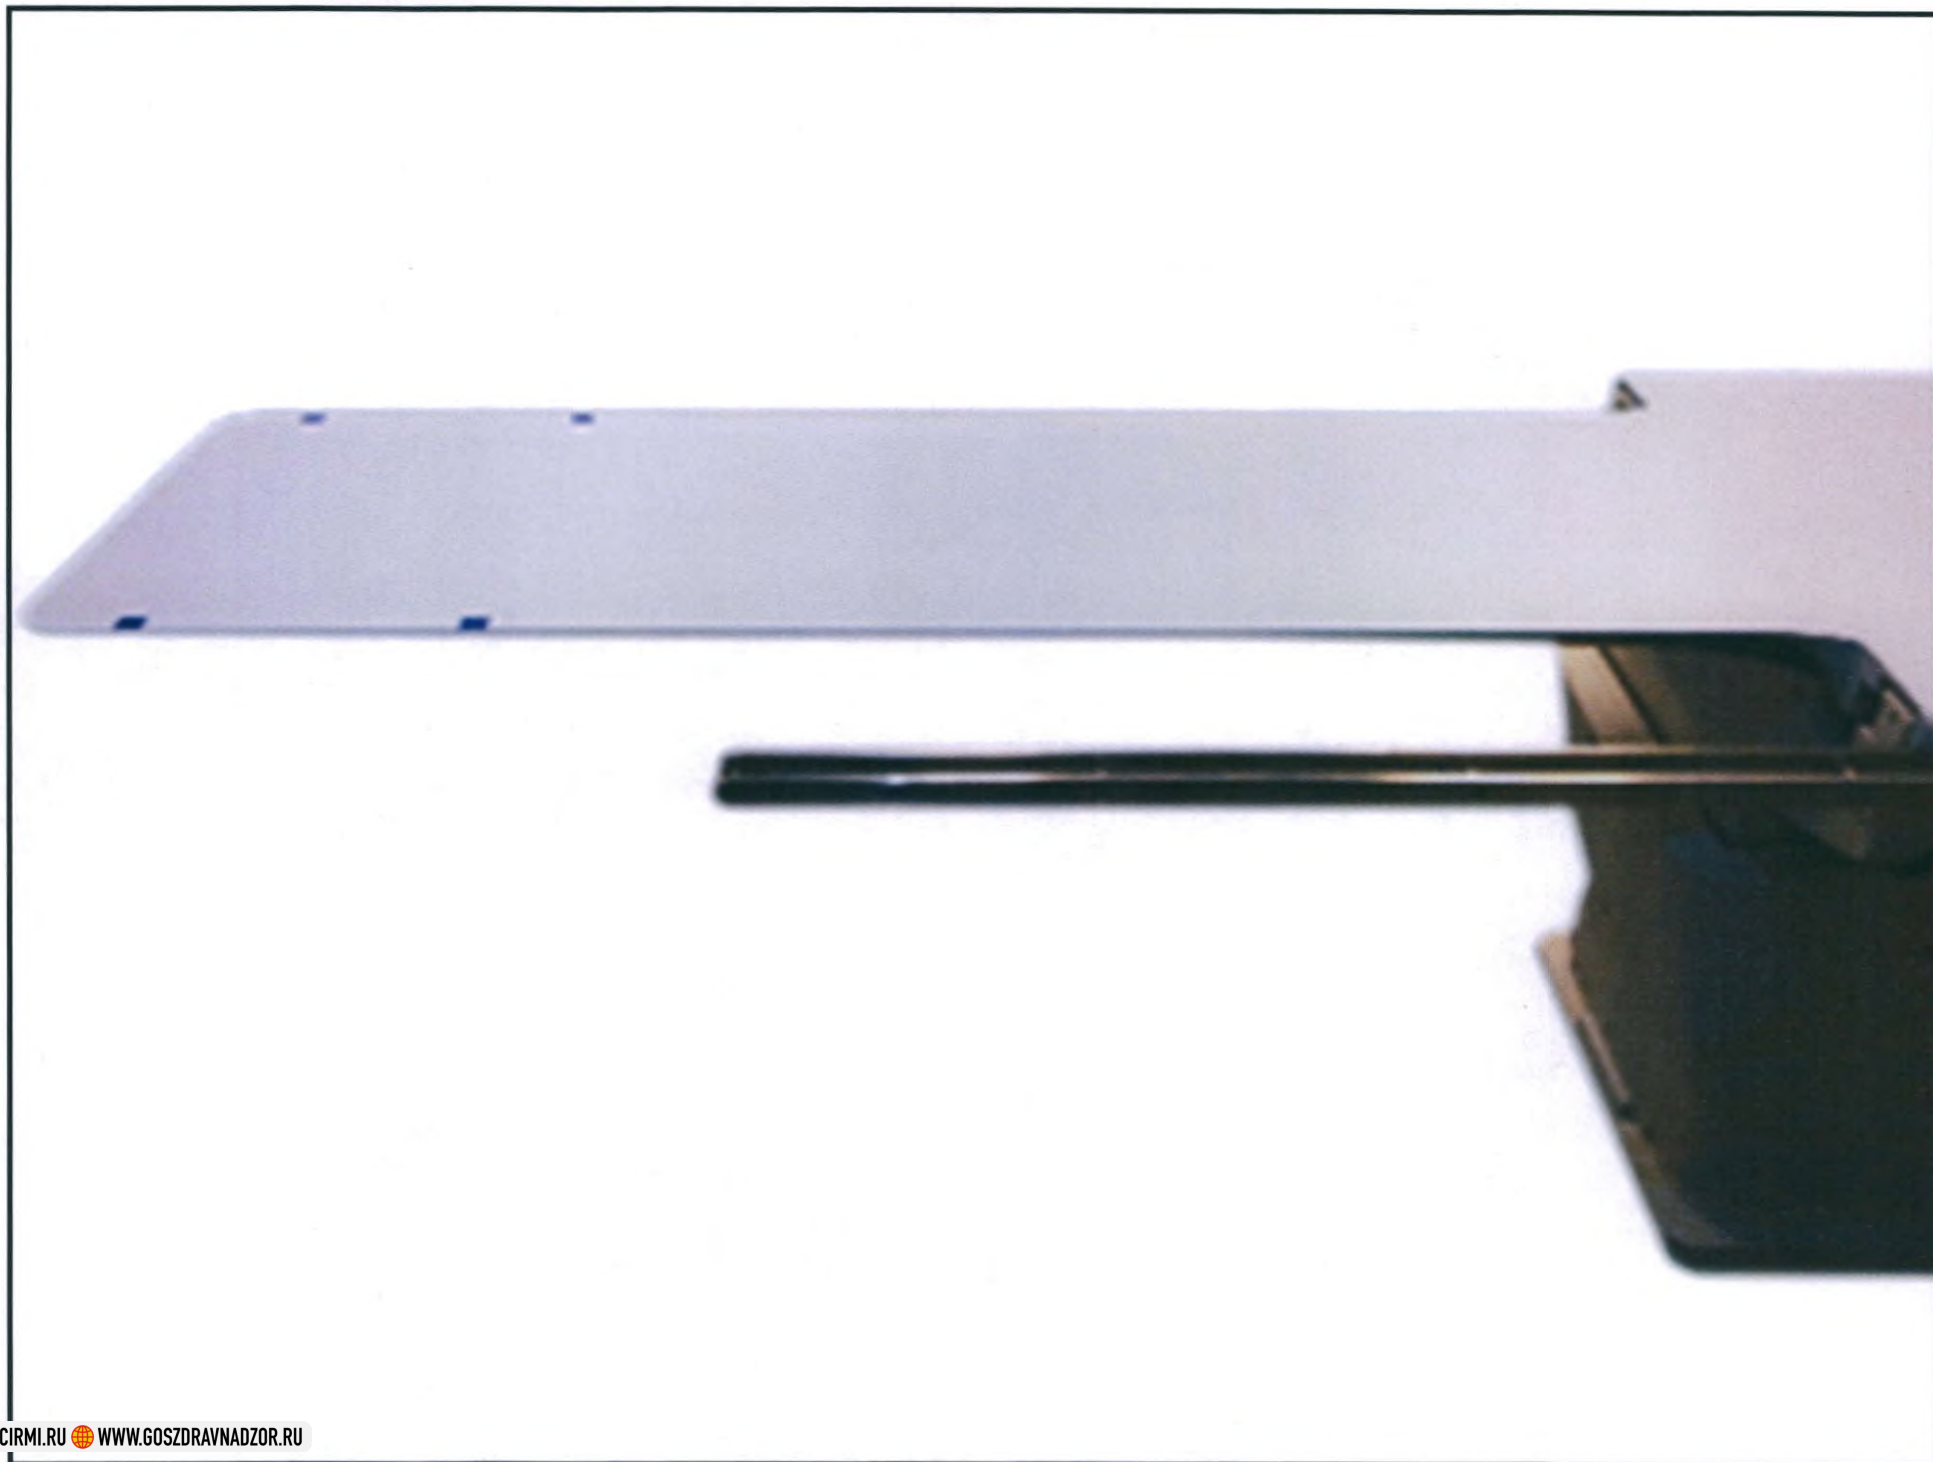

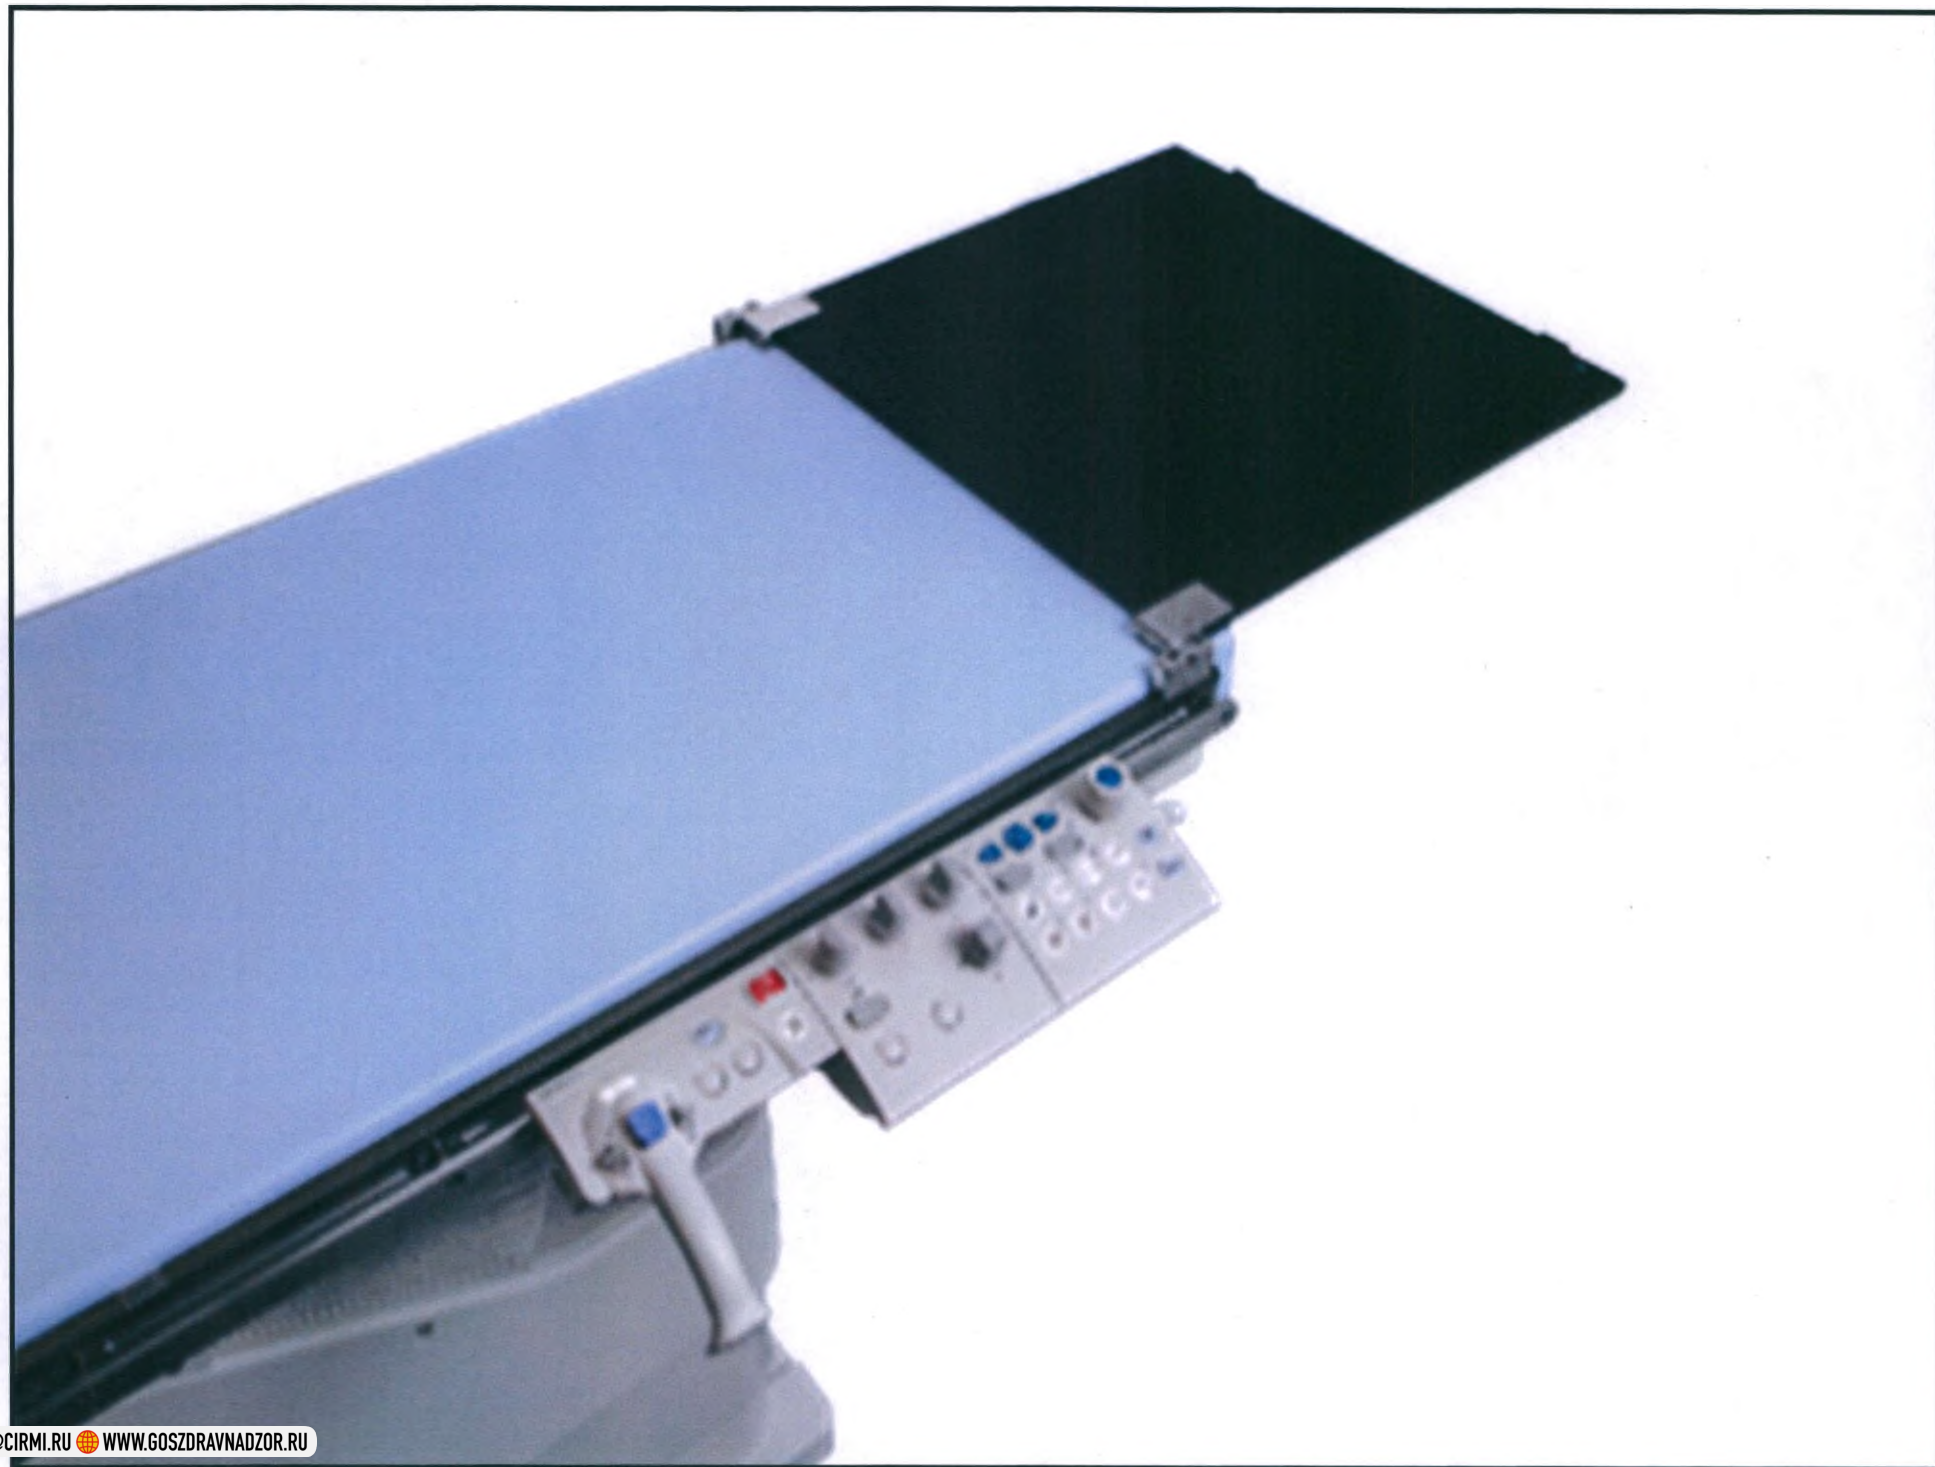

22. Комплект управляющего переключателя стола на головном конце (для CAT-850B).



23. Накладка для деки стола толщиной 5 см (для CAT-850B).




24. Боковая планшетная консоль стола.





25. Вспомогательная планшетная консоль.




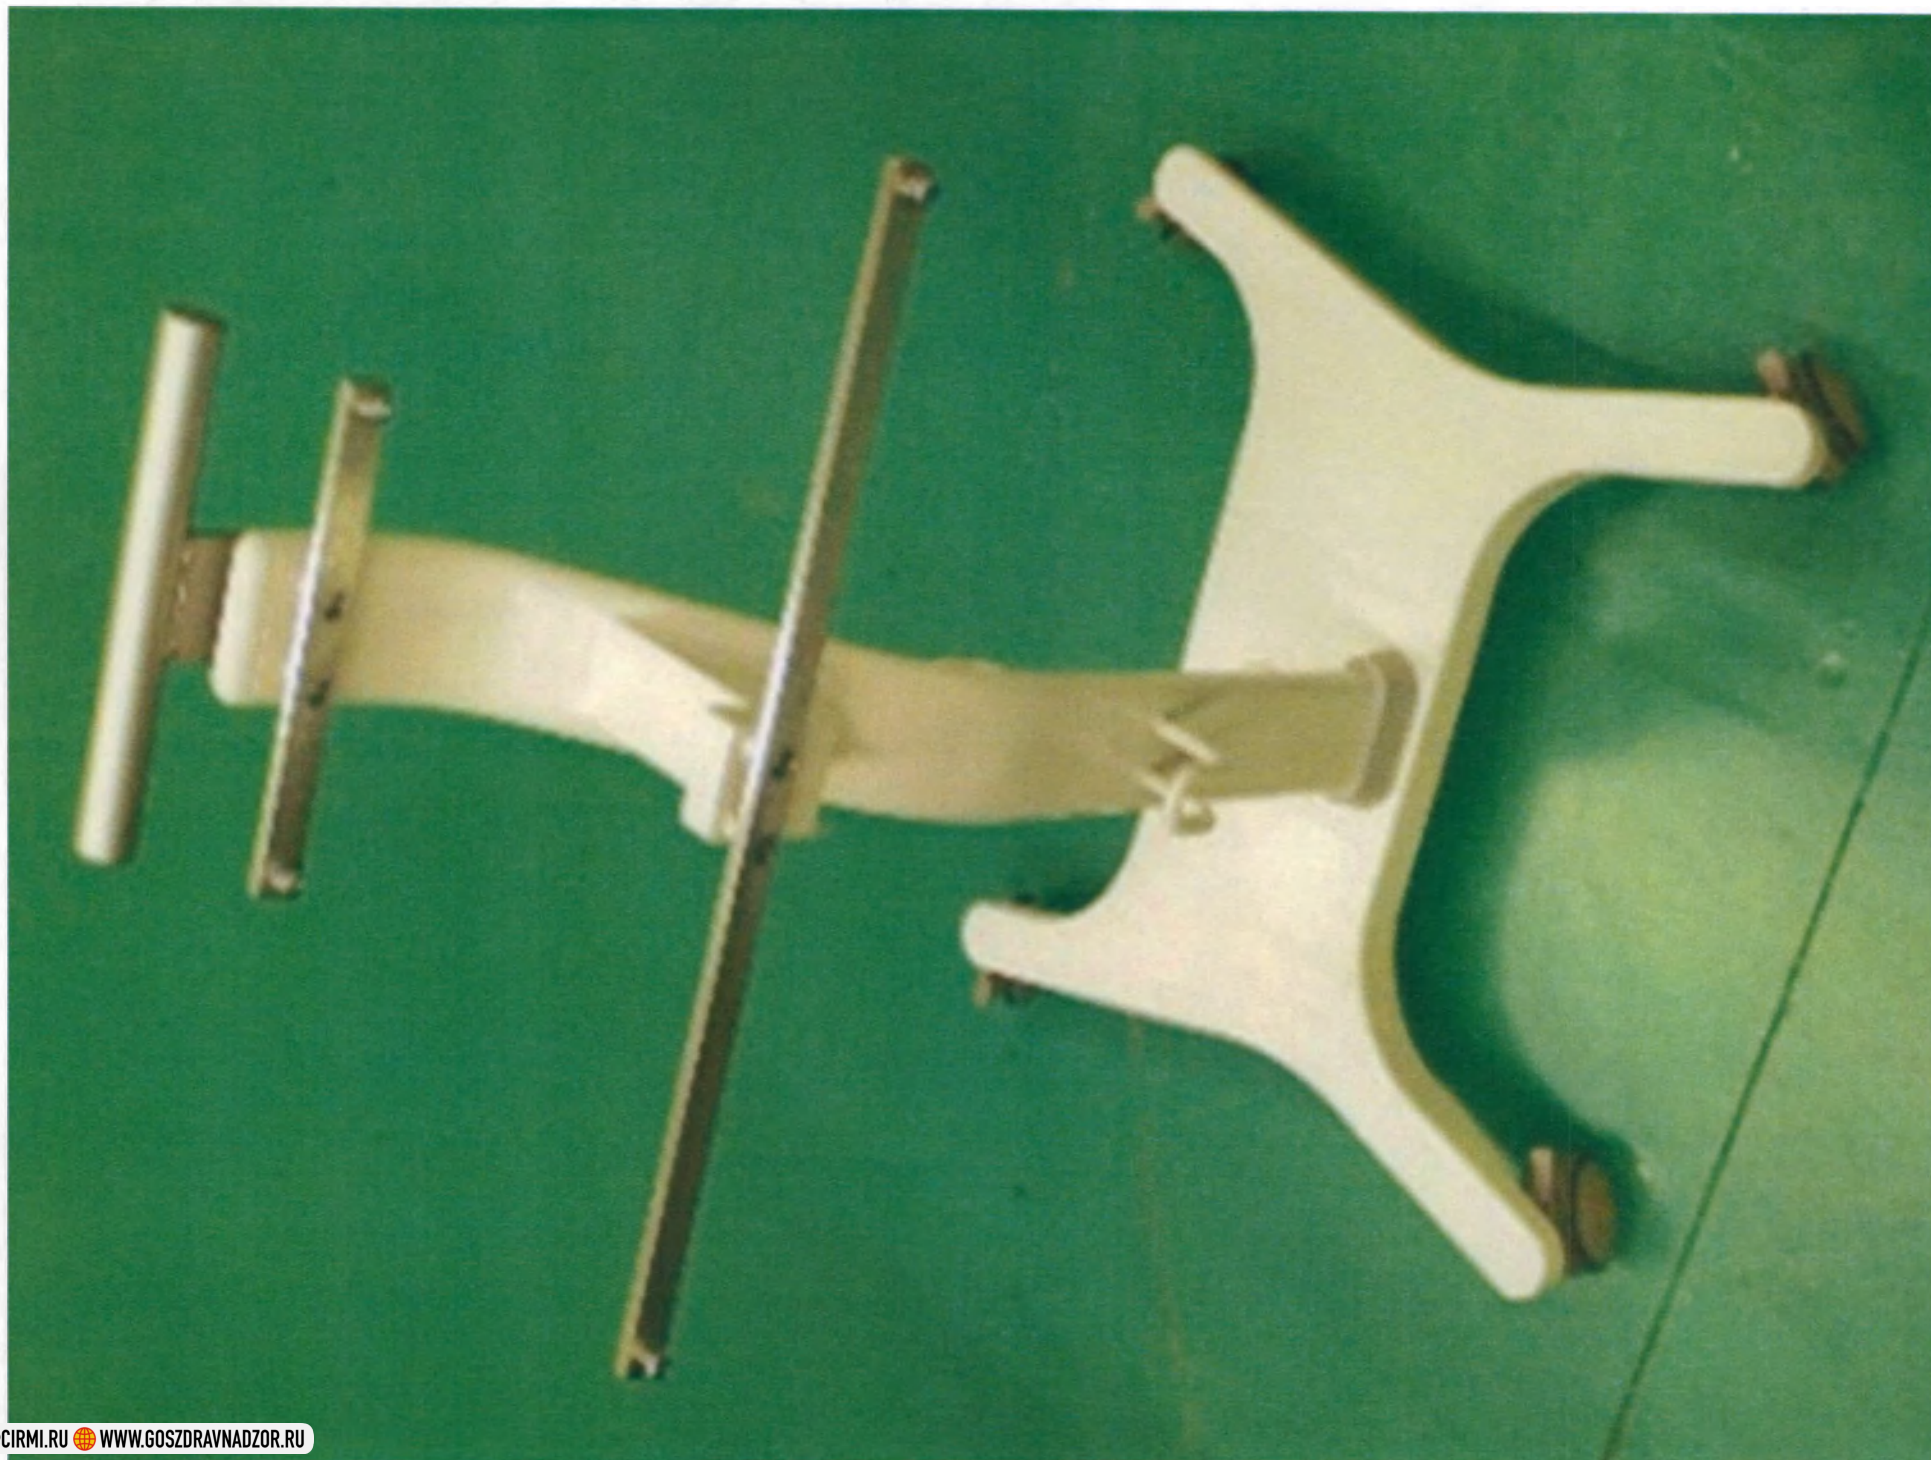


26. Боковая планшетная консоль стола с блоком переключателей.

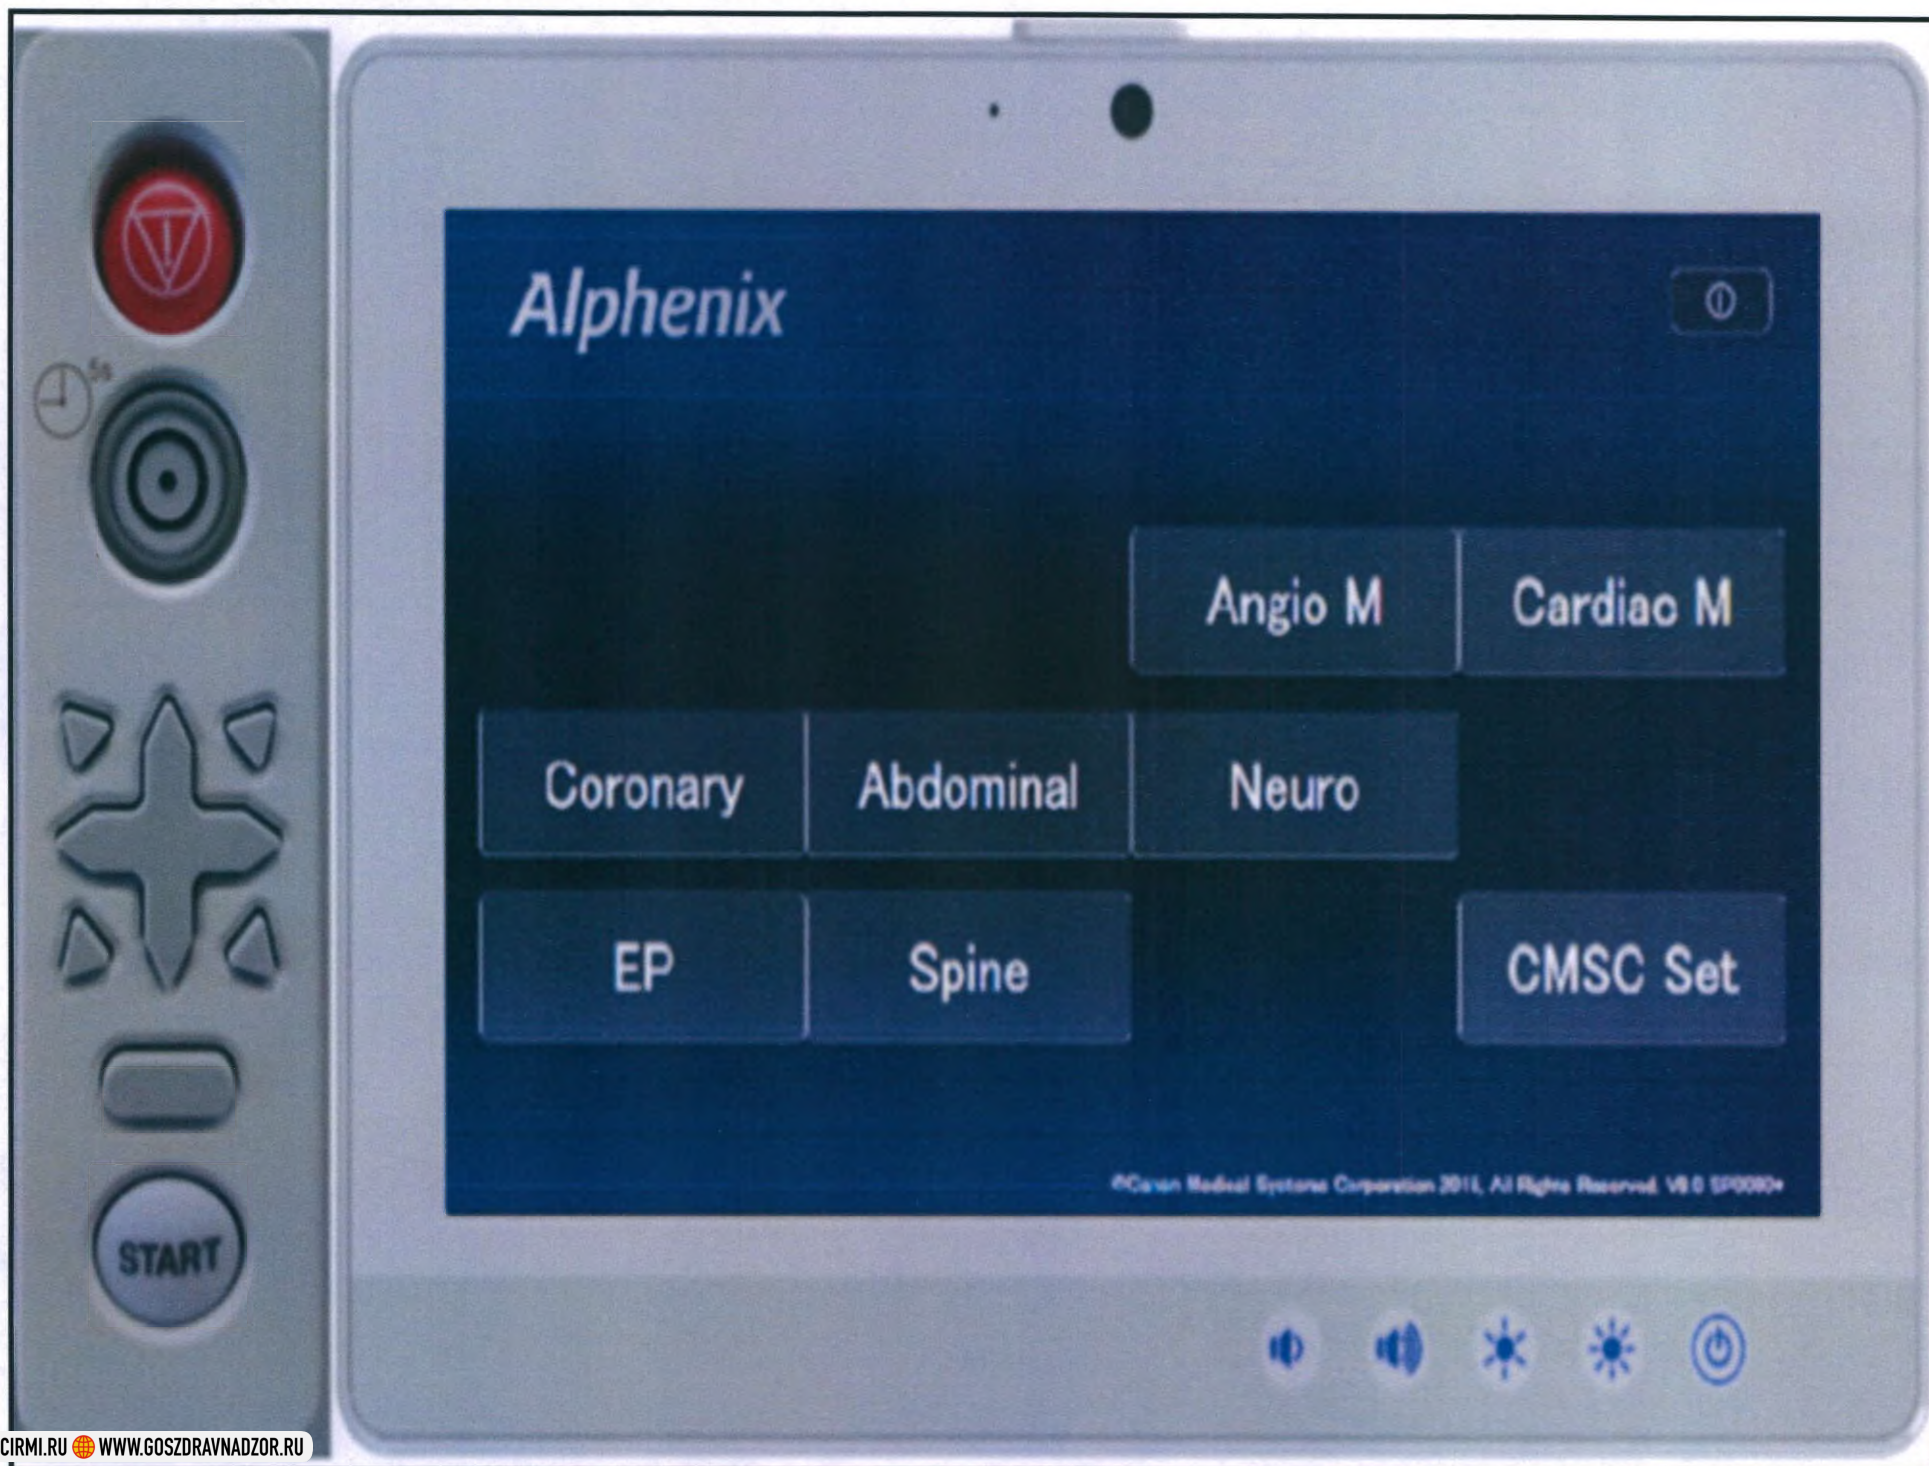

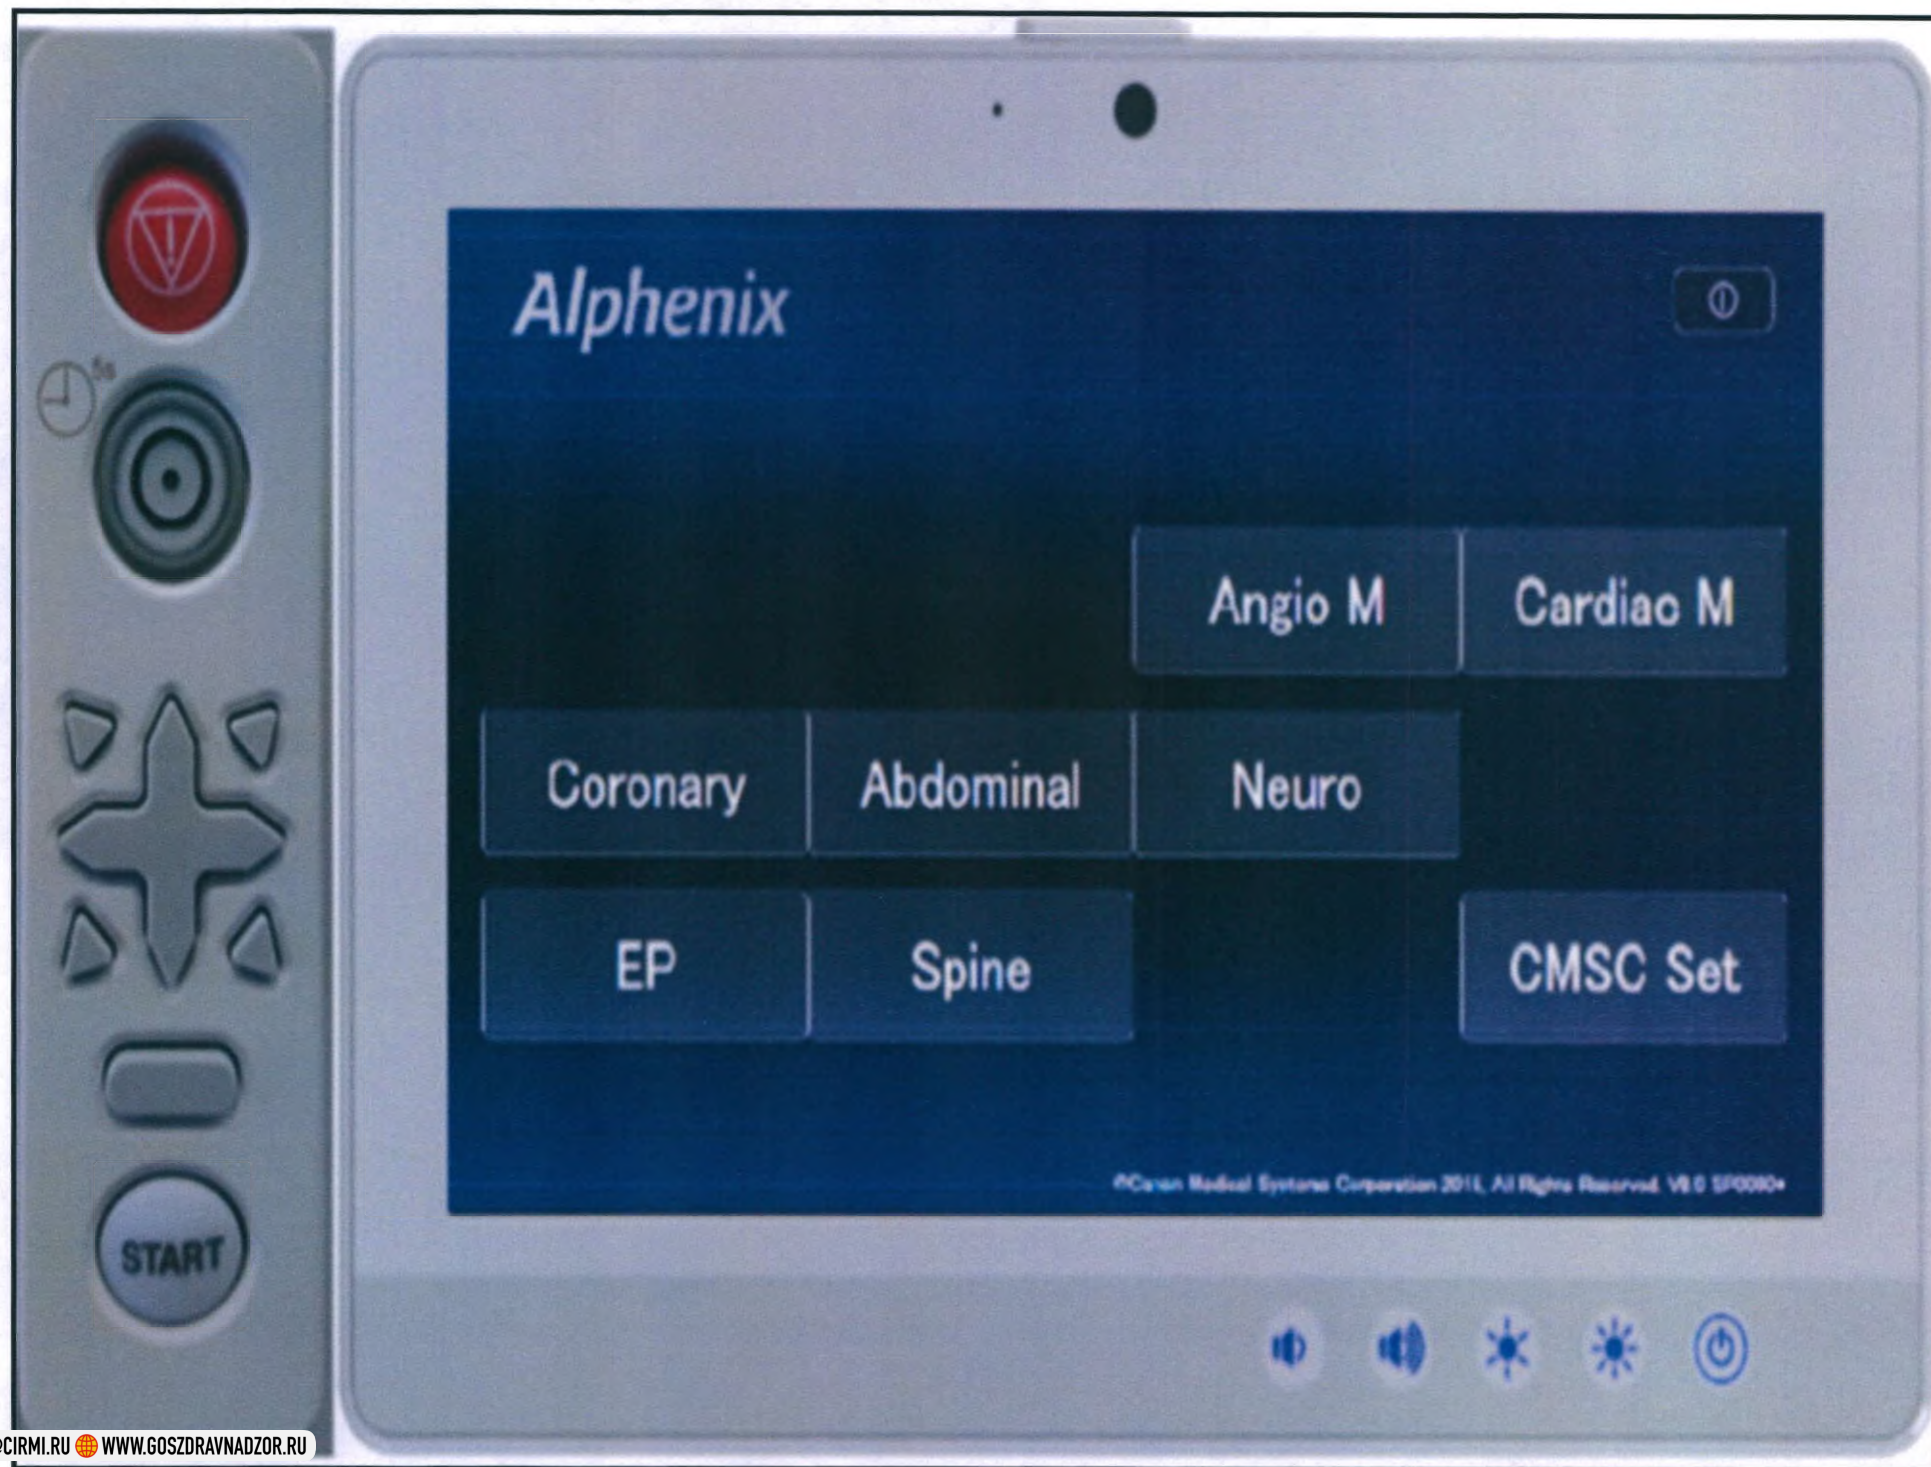

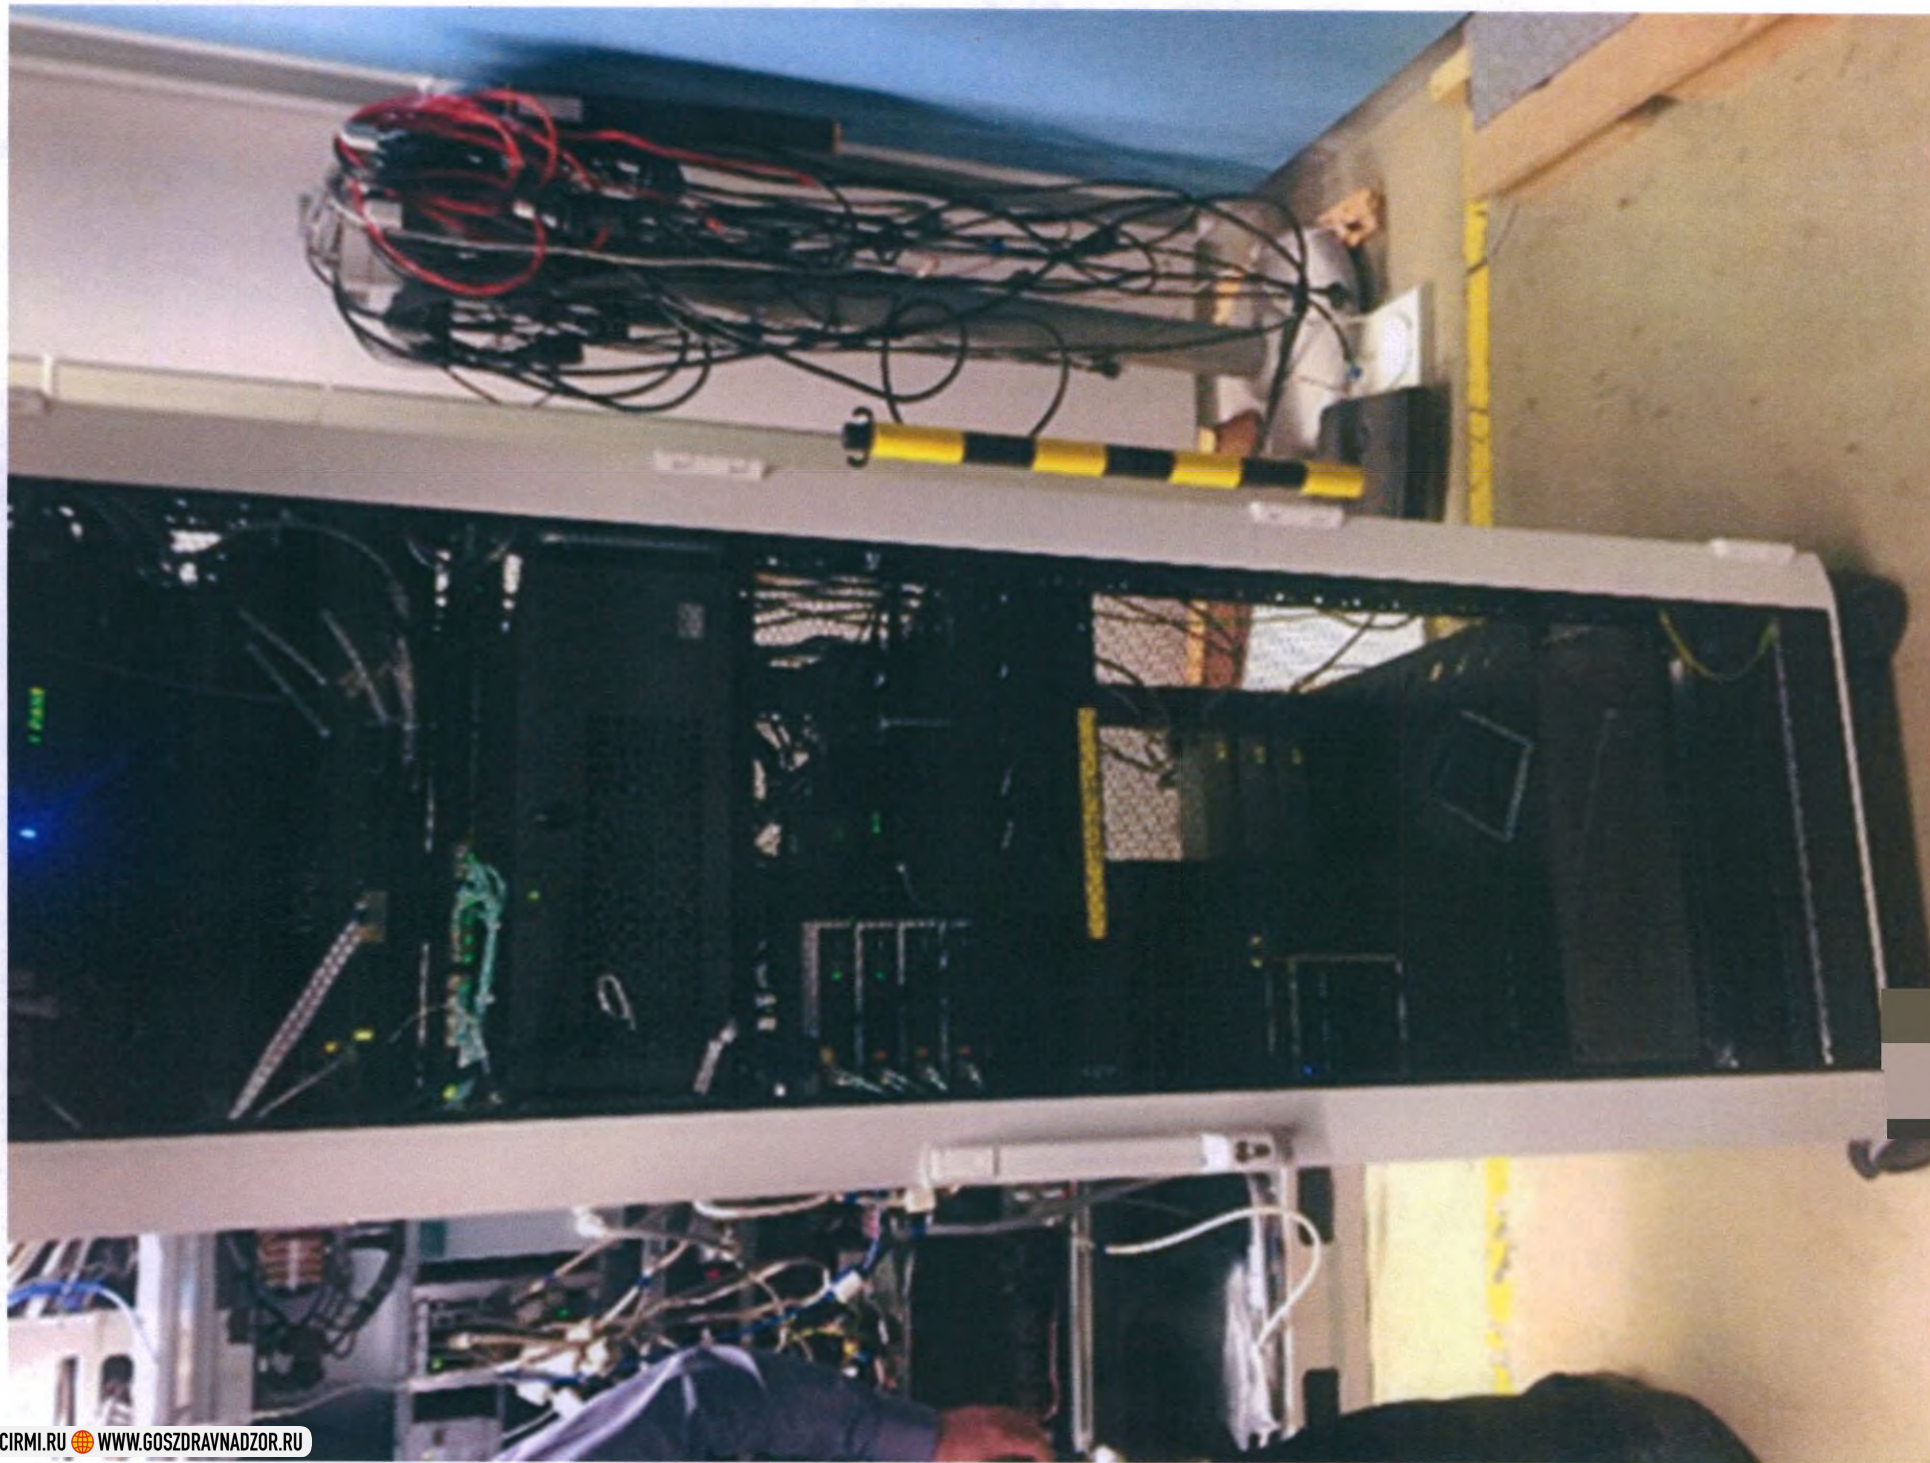

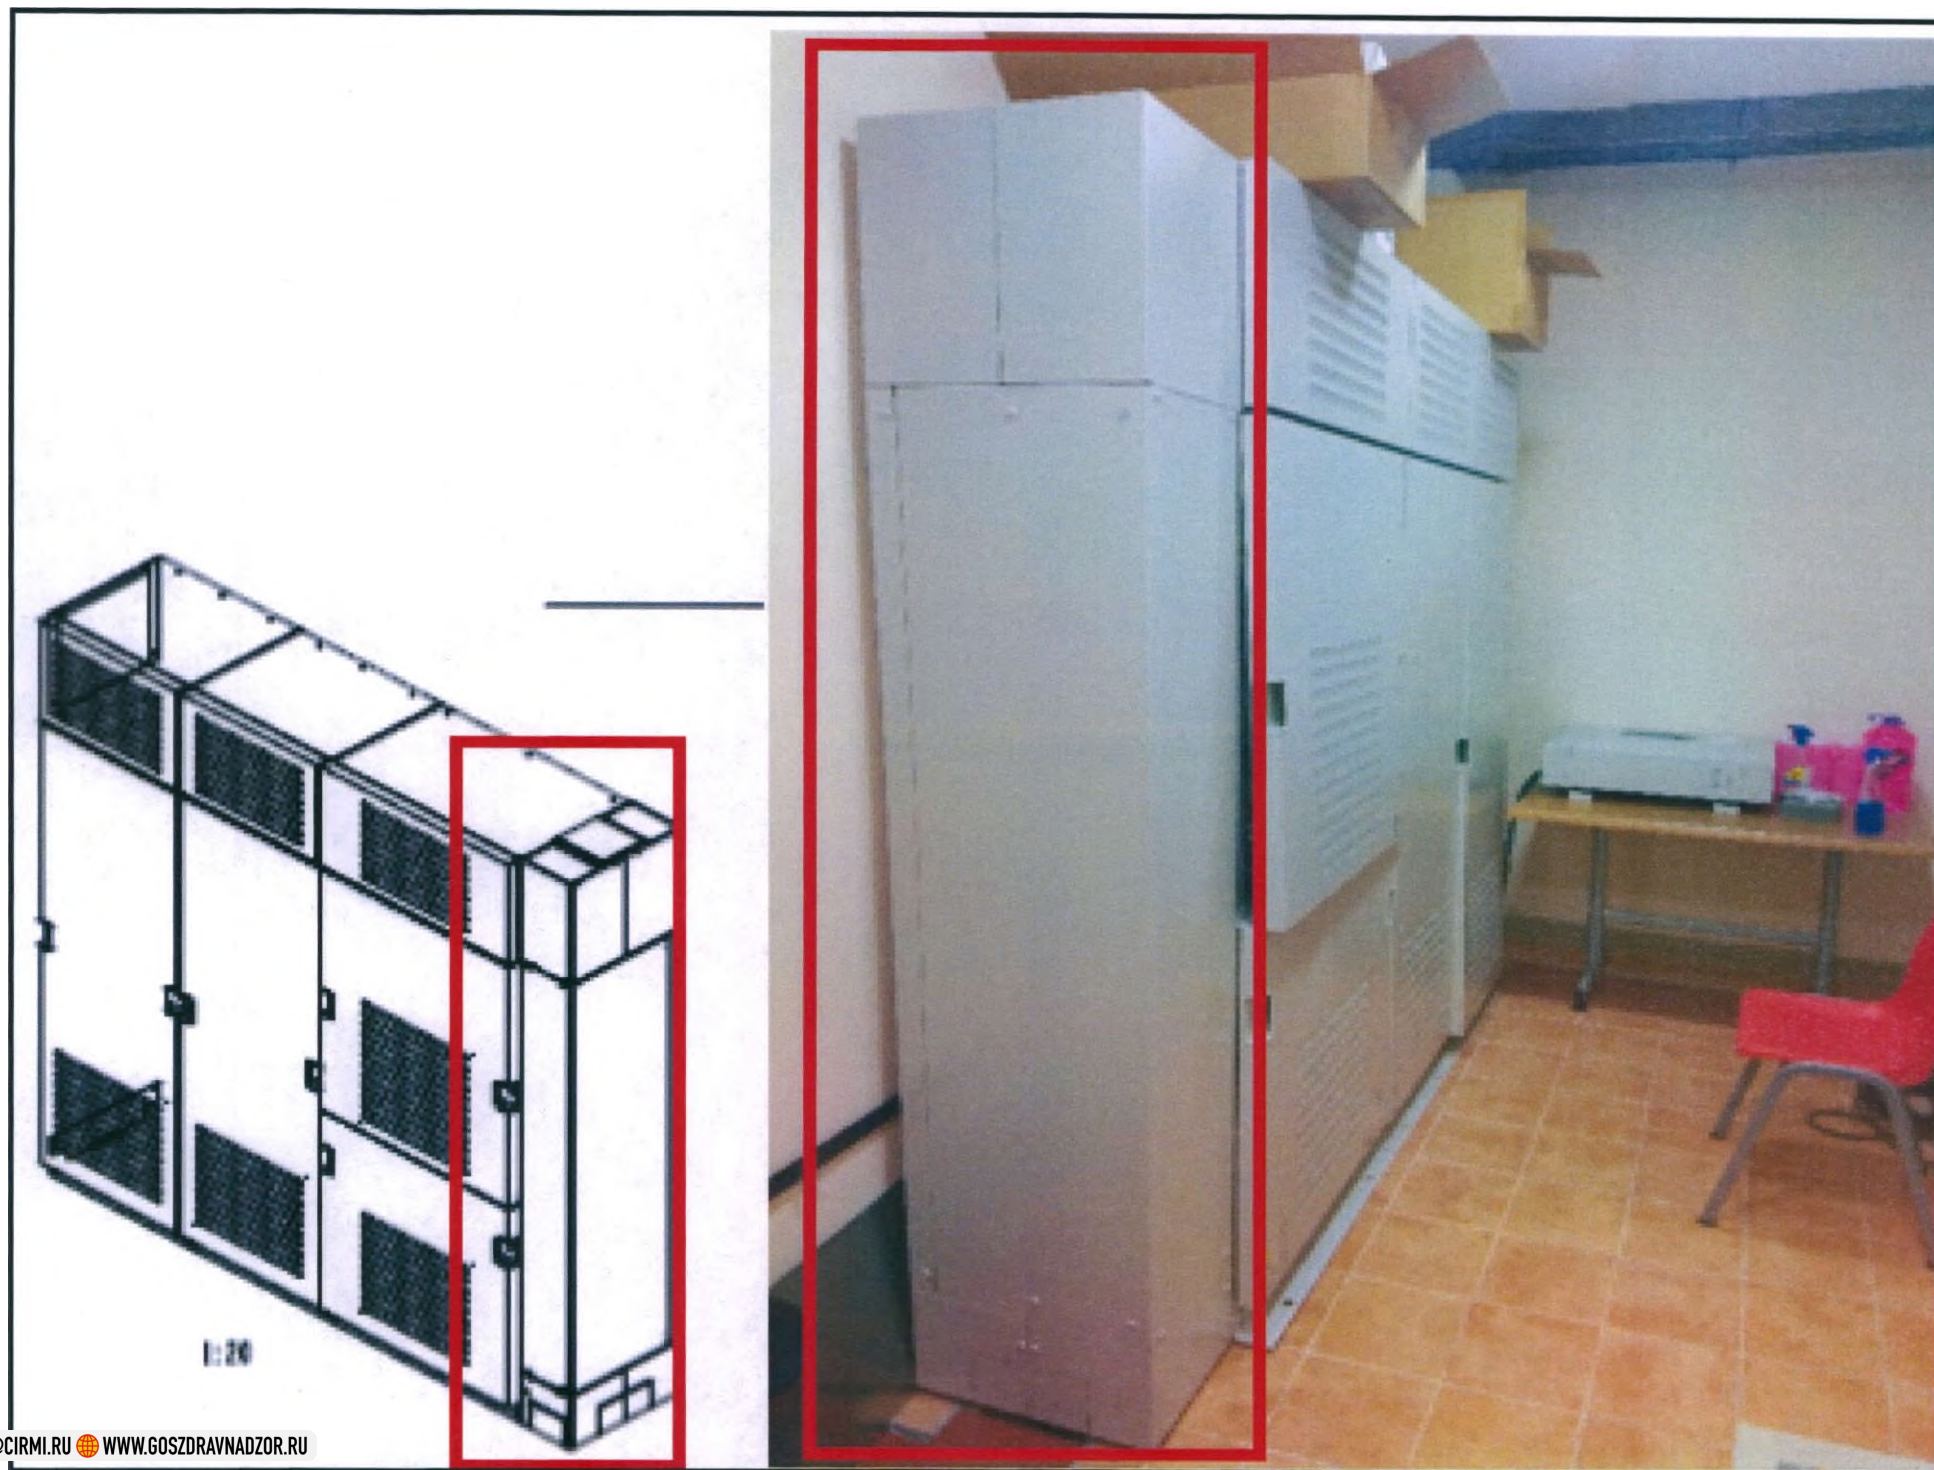




31. Комплект для добавления контрольного монитора.



32. Комплект принадлежностей для ступенчатой ЦСА (Шаговое устройство).




Шаговое устройство
встроено внутрь
CAT-850B/B1

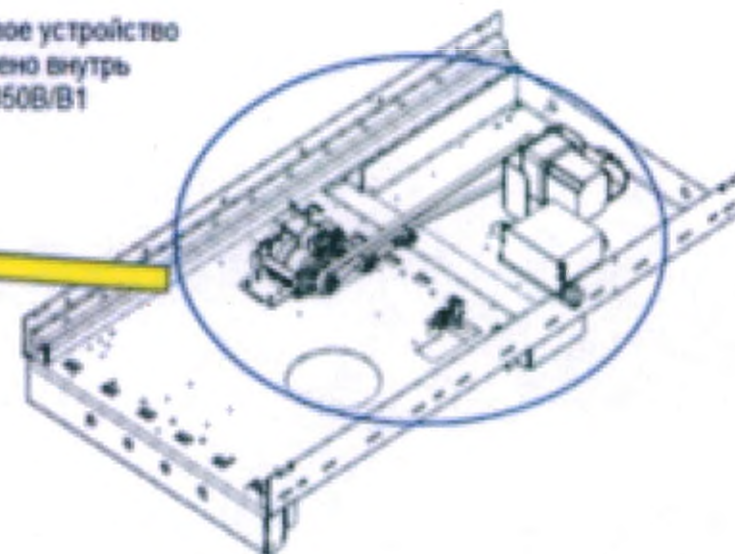



34. Модуль ротационной ЦСА.



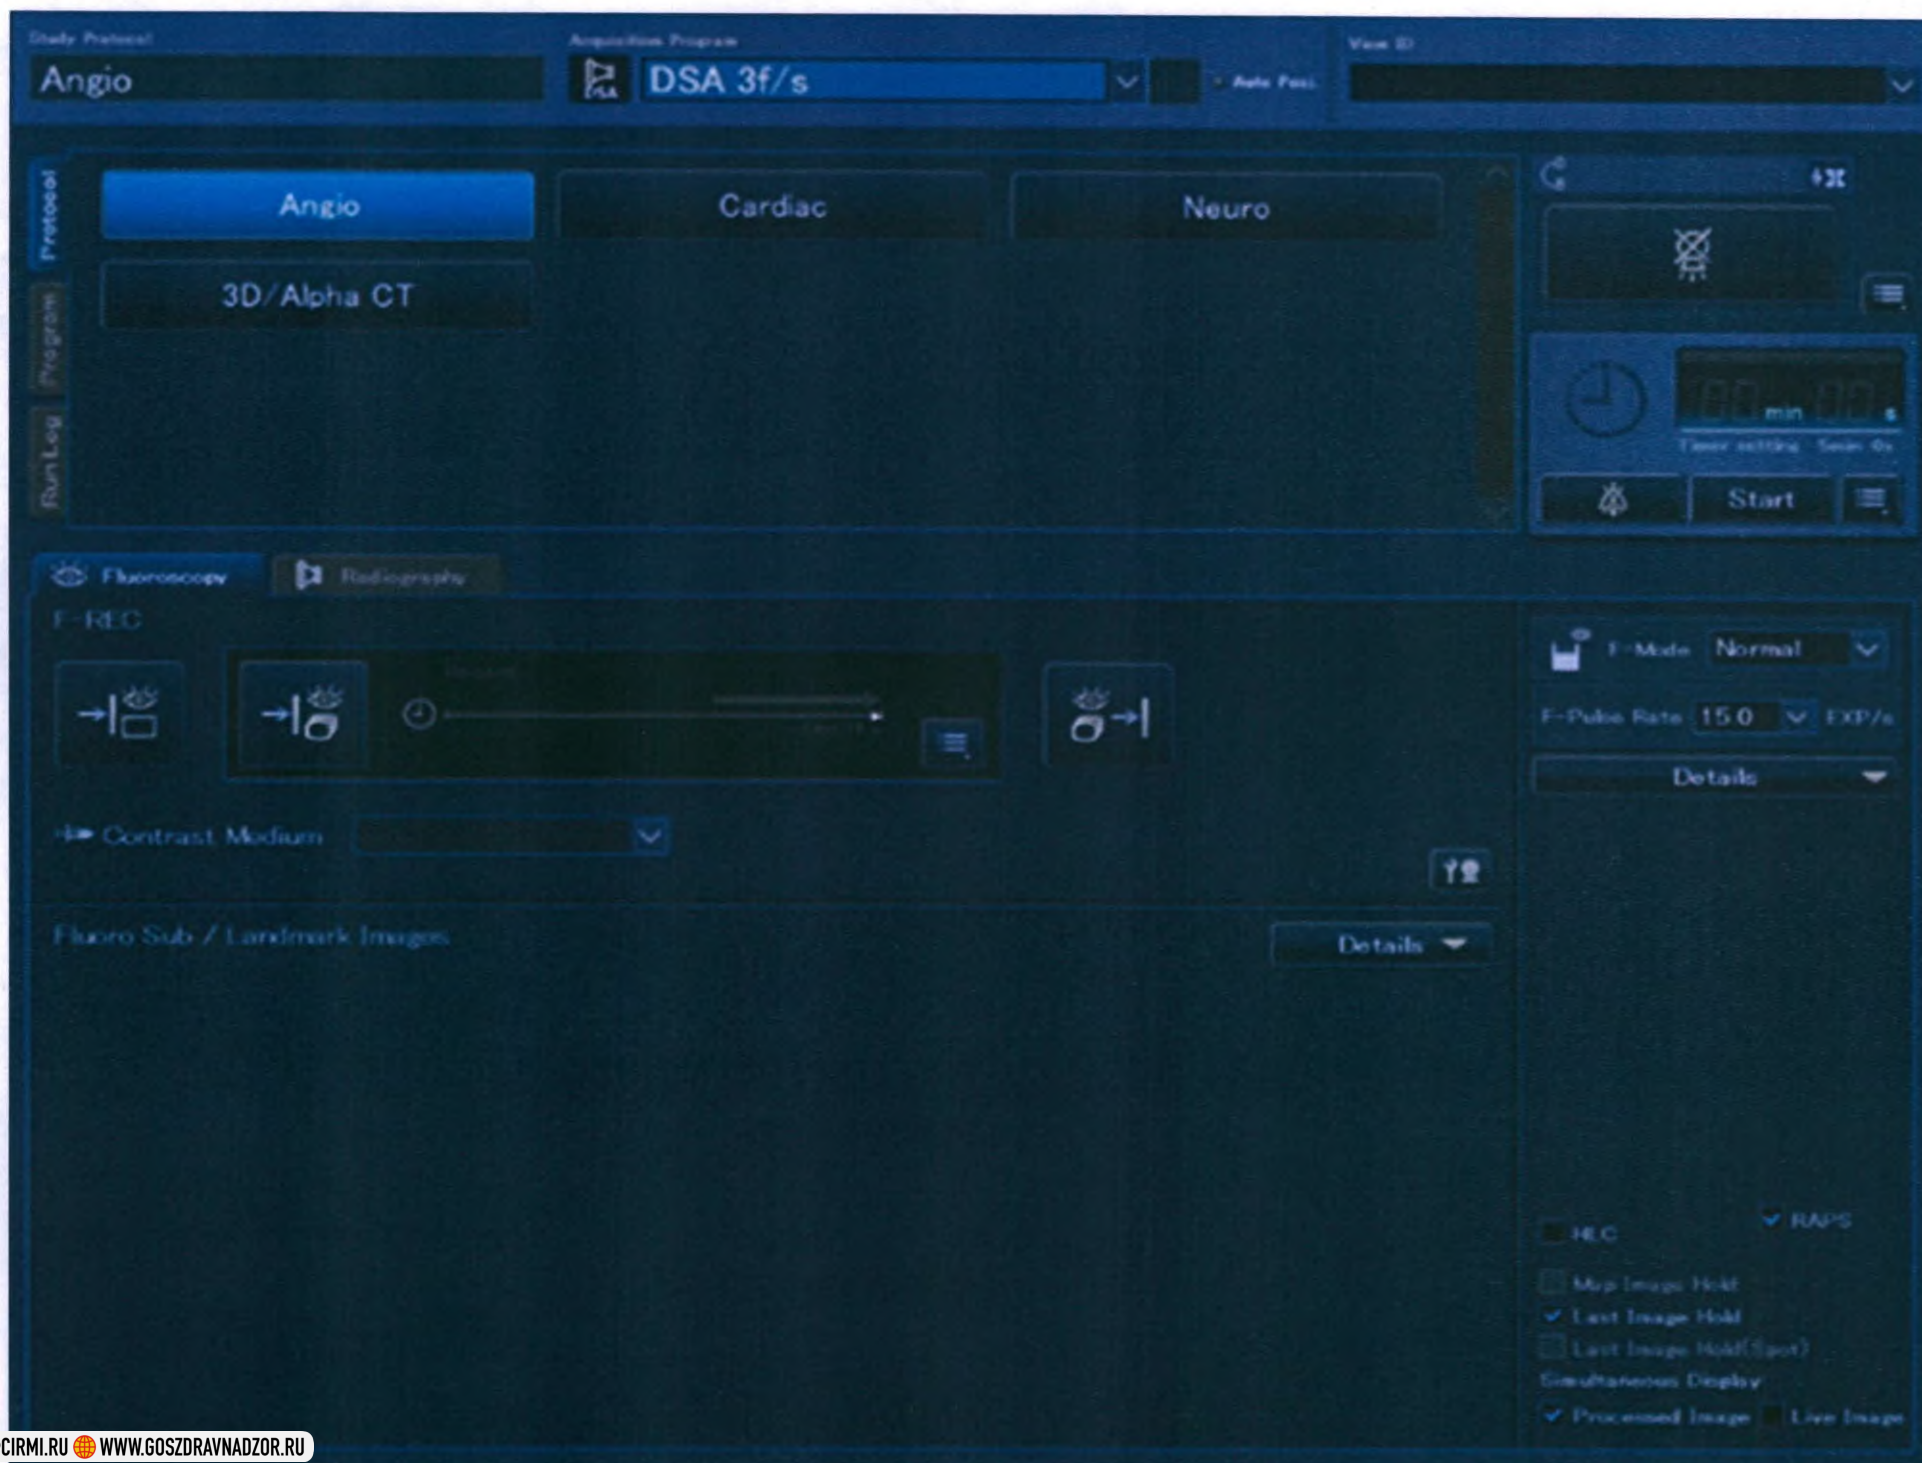

36. Модуль для низкоконтрастной визуализации (Alpha CT).

Study Protocol: 3D/Alpha CT Acquisition Program: CT Multi 5s 12" Auto Posi. View ID: []

Protocol Parameters

System Mode: ☐ Cardiac ☒ Angio 1

☐ Sequential Navi

[Transfer] [Favorite]

[SystemParam1] [SystemParam2]

[Clock] min s Floor setting: Scan On [Start]

☒ Fluoroscopy ☒ Radiography

Tube Voltage: 75 kV Focus: [] [] [] [] [] []

Tube Current: 320 mA Gain: 100 [Set]

Pulse Width: 40.0 ms

Target Dose: 0.88 μ R Target Dose Details

☐ Test Shot [Advanced Presets] [AEC Param.]

Contrast Medium: [] Floor Rot(deg): 0

[Phase 1] [Phase 2] [Phase 3]

Exposure Time(s): 4.0 4.0 4.0

Delay From Injection Start(s): 6.0 16.0 26.0

Speed(deg./s): 50.0 Deg./Frames: 1.0

Rate(f/s): 60.0 Frames: 223 x 3

SID: 120 FOV: 12.0

☒ FOV Linkage

Radiographic Range: RAO 120 LAO 120 CRA 0 CRA 0

☐ Preset Angle


Function: *Quality Mode: Vessel Size


1: Done/Vessel 512

2: No Select 512

Total Time(s): 30.0 No. of frames: 669 Total Deg: 720

[OK] [Cancel]

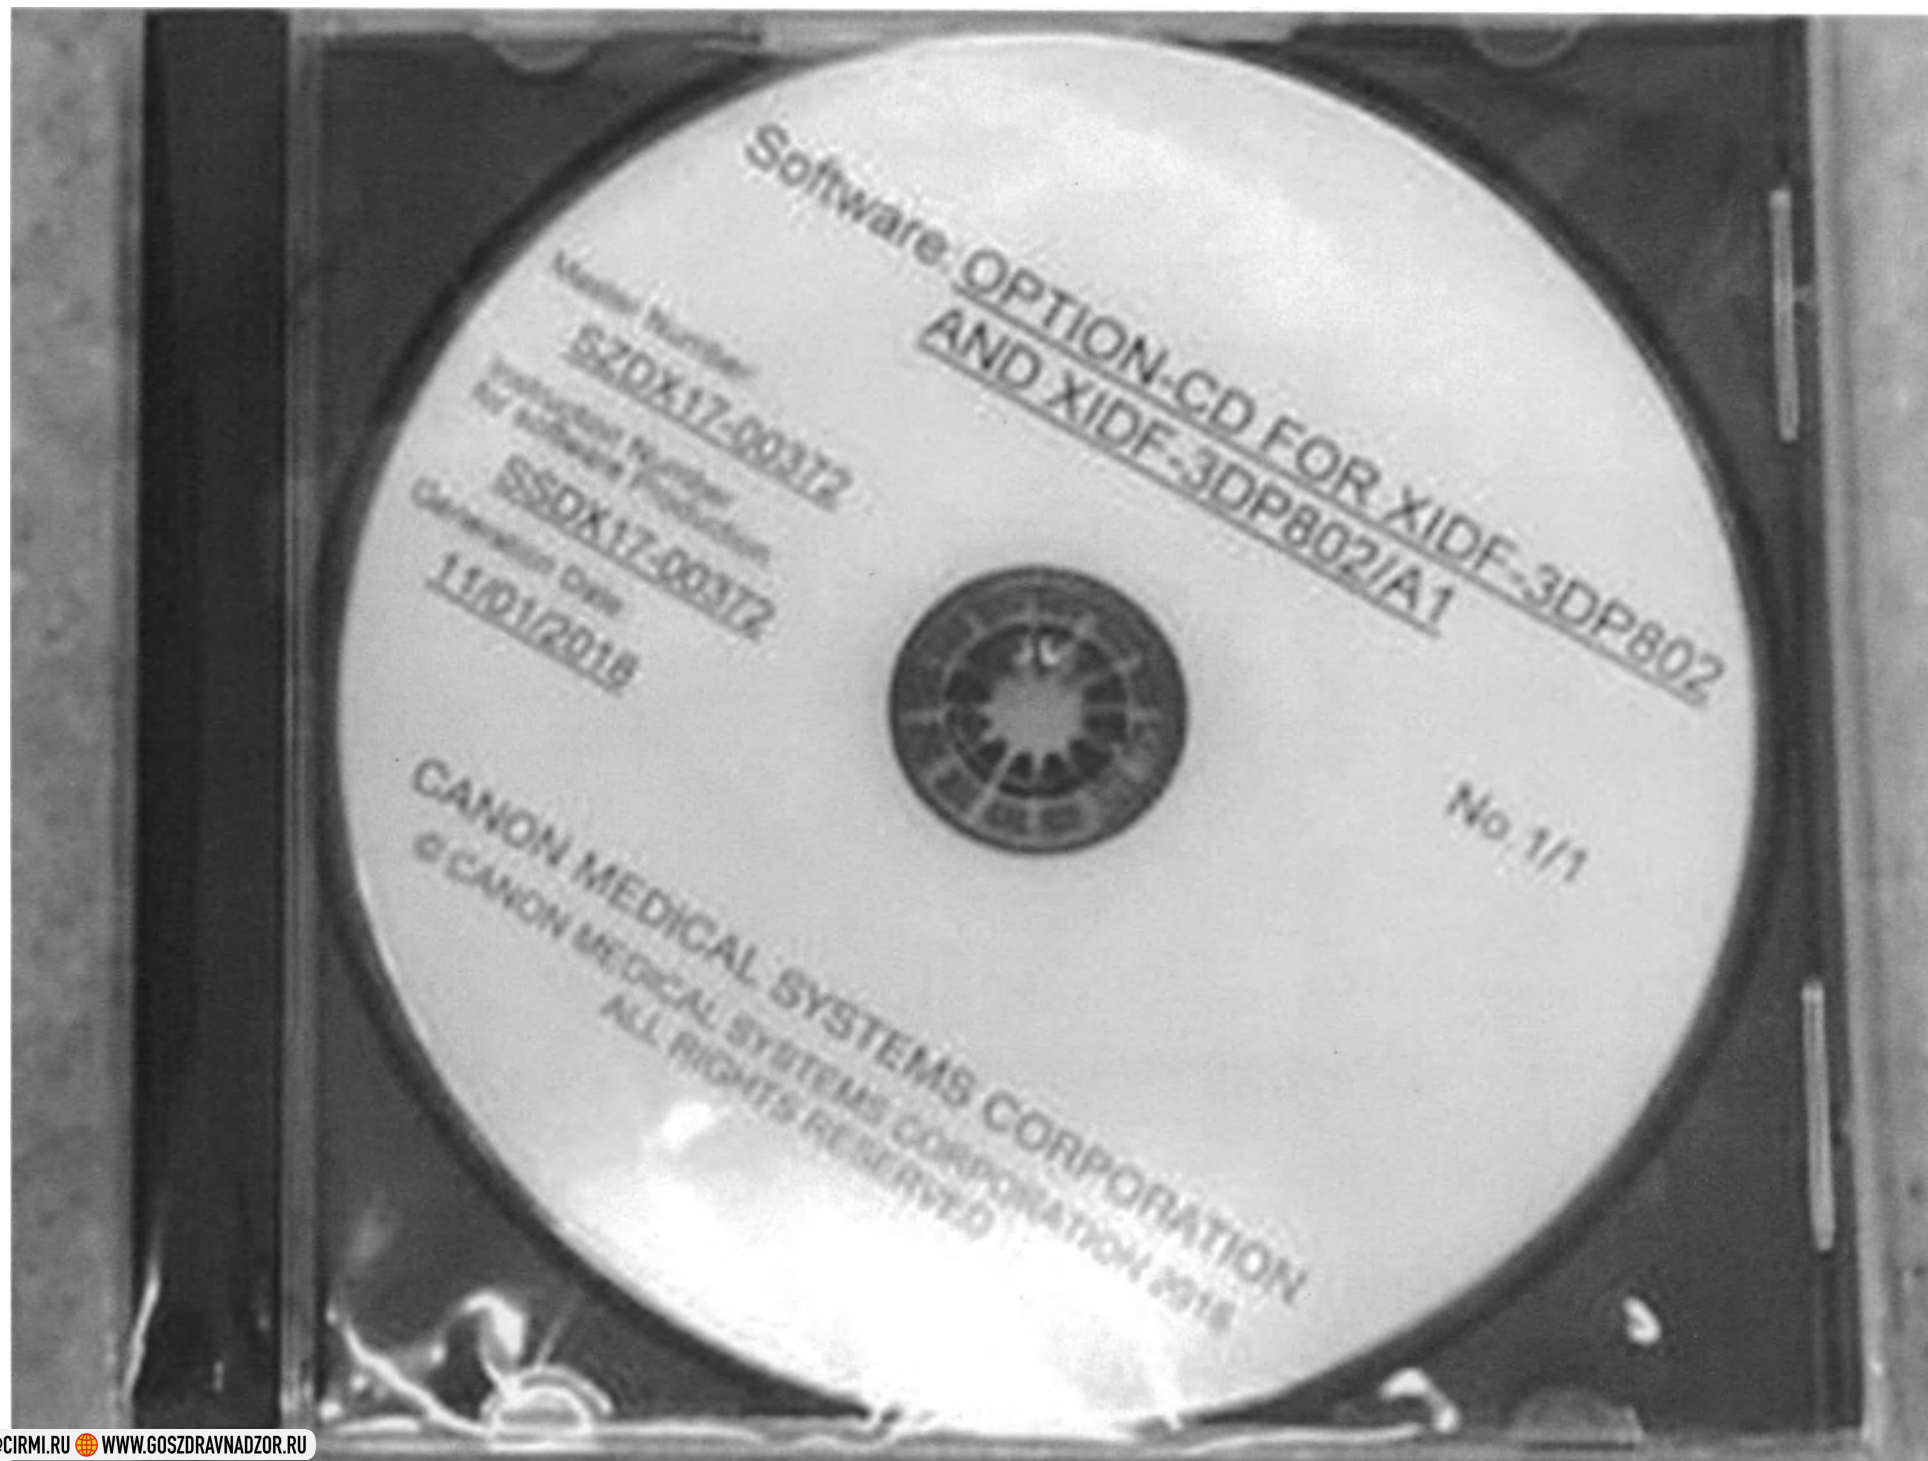

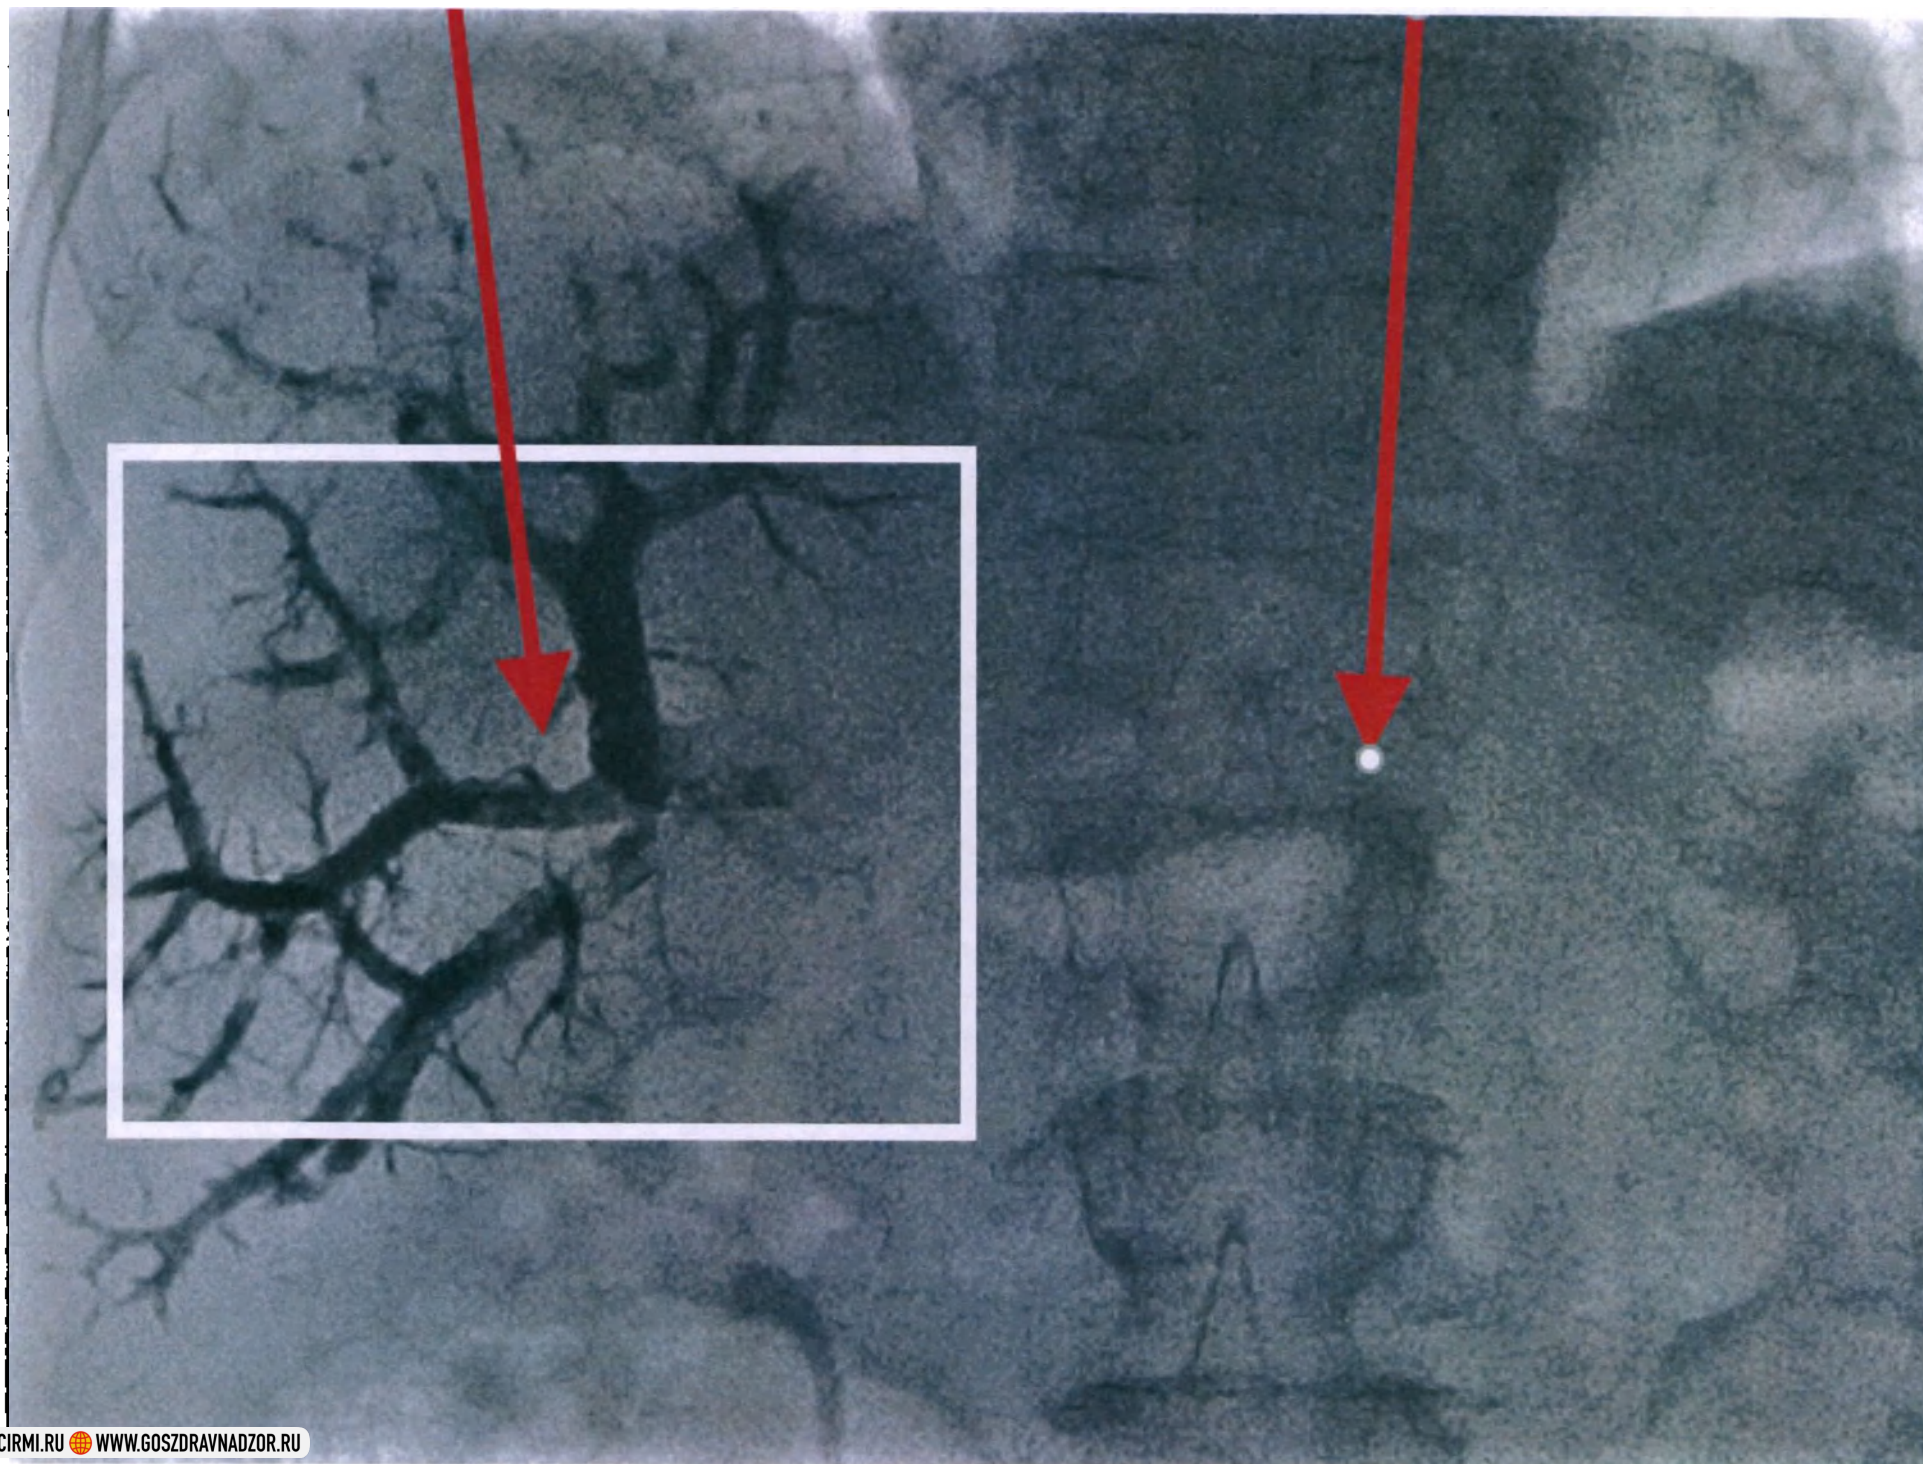

39. Базовый модуль для приложения клинического анализа.

91

CAAS SETTINGS

CAL | LVA | RVA | QCA | QVA | About

Local Reference Method

☒ Mean local 1 ☐ Mean local 2 ☐ Interpolated

Default Analysis Method [Total Analyzed Segment ▼]

Local Diam Average Width [3] mm


Local Ref Average Width [3] mm

Maximum Diameter [50]


☒ Snap Lesion At Local Minimum


Default


OK Cancel

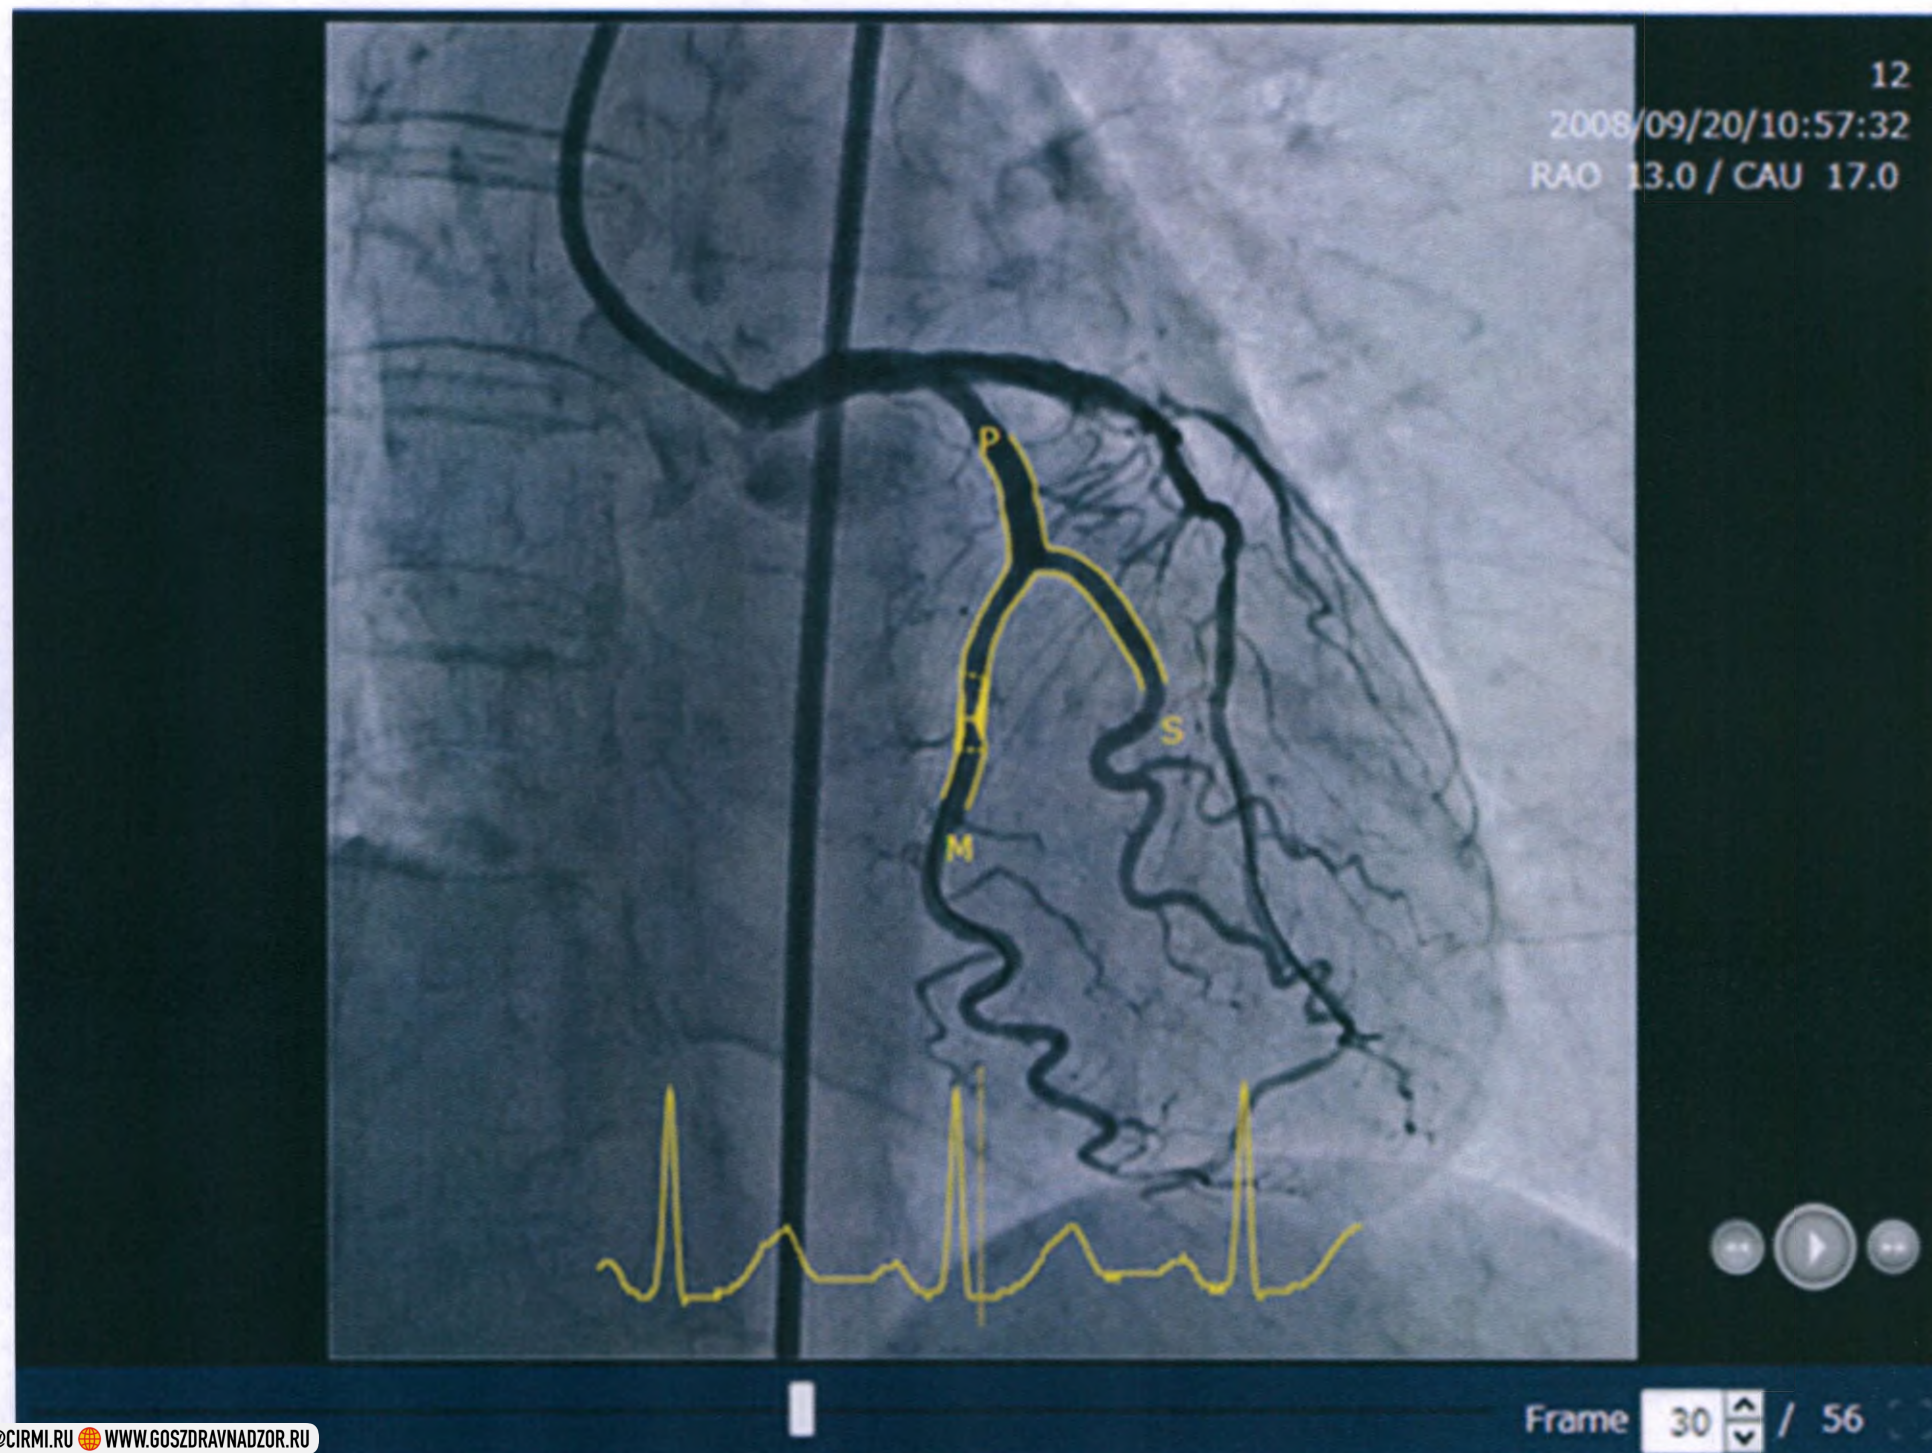





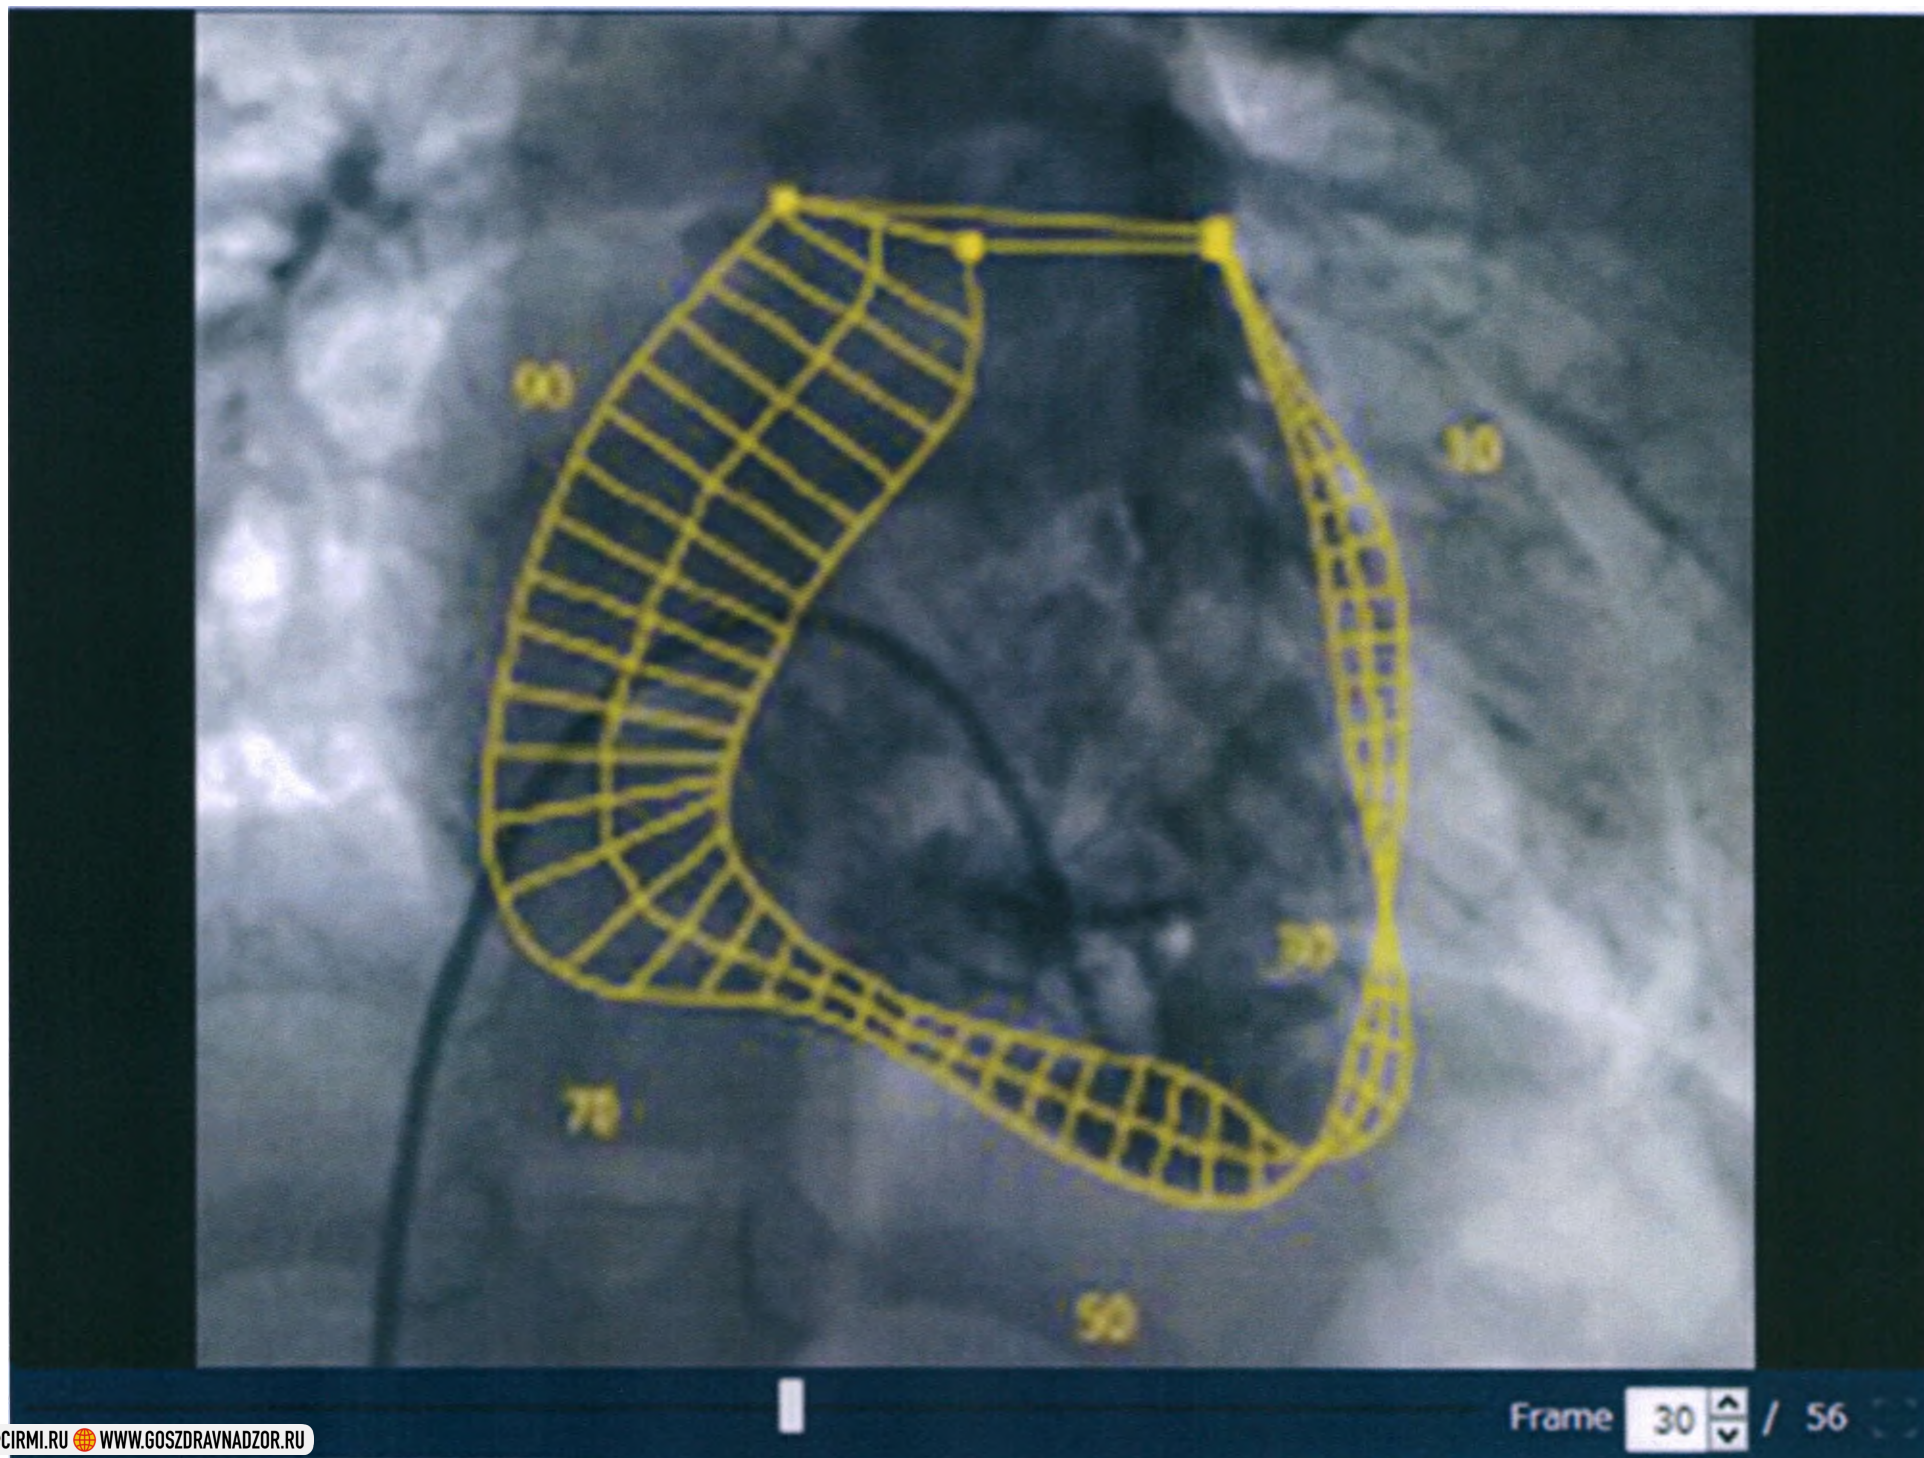

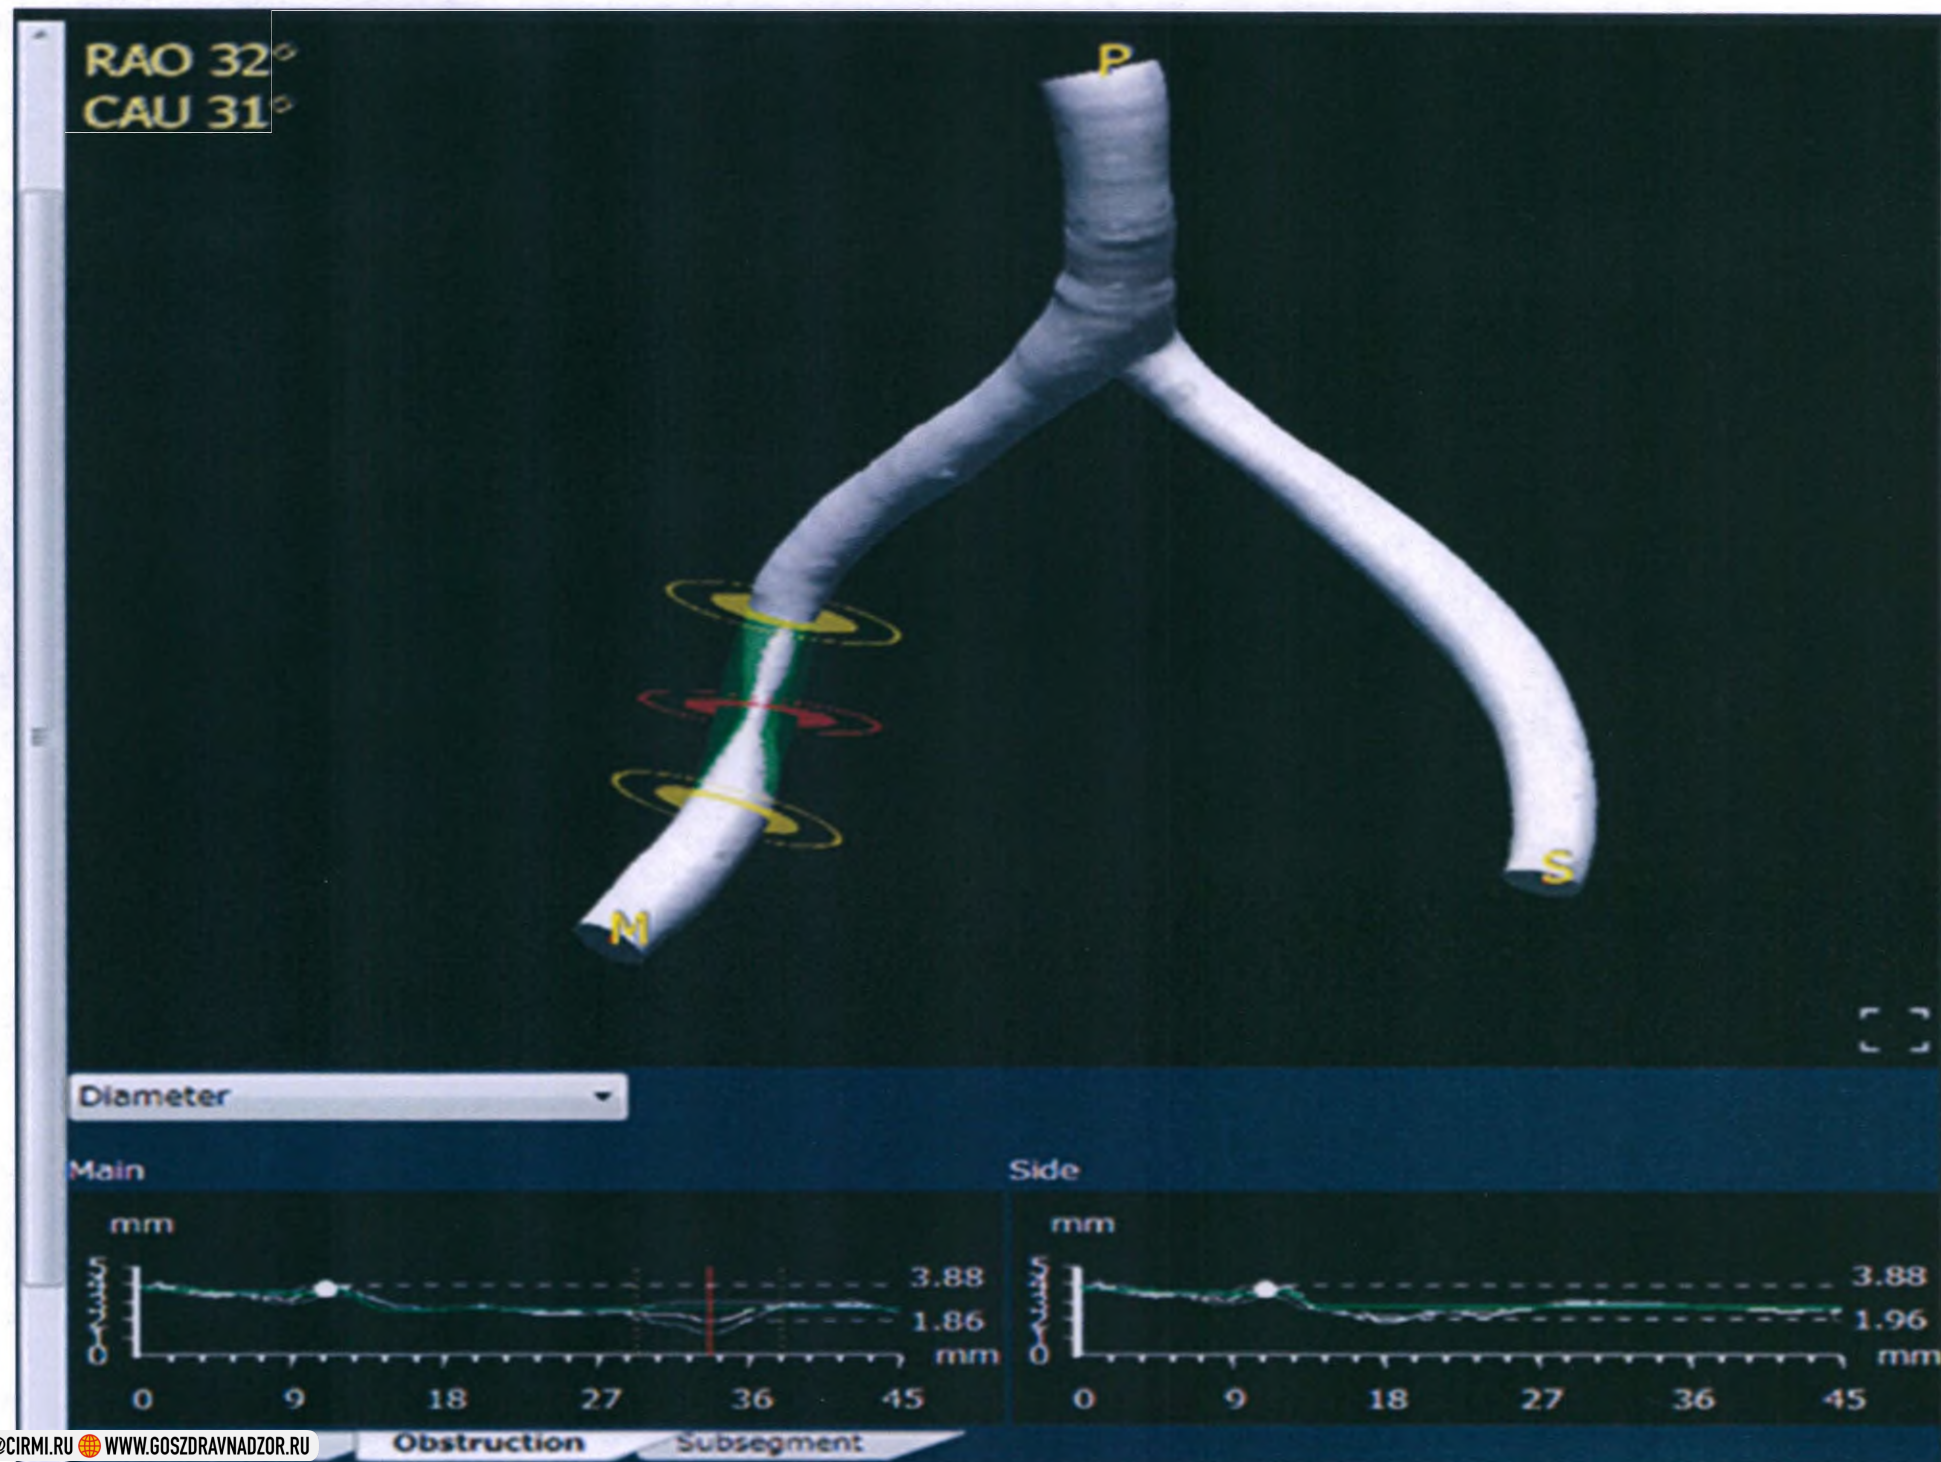


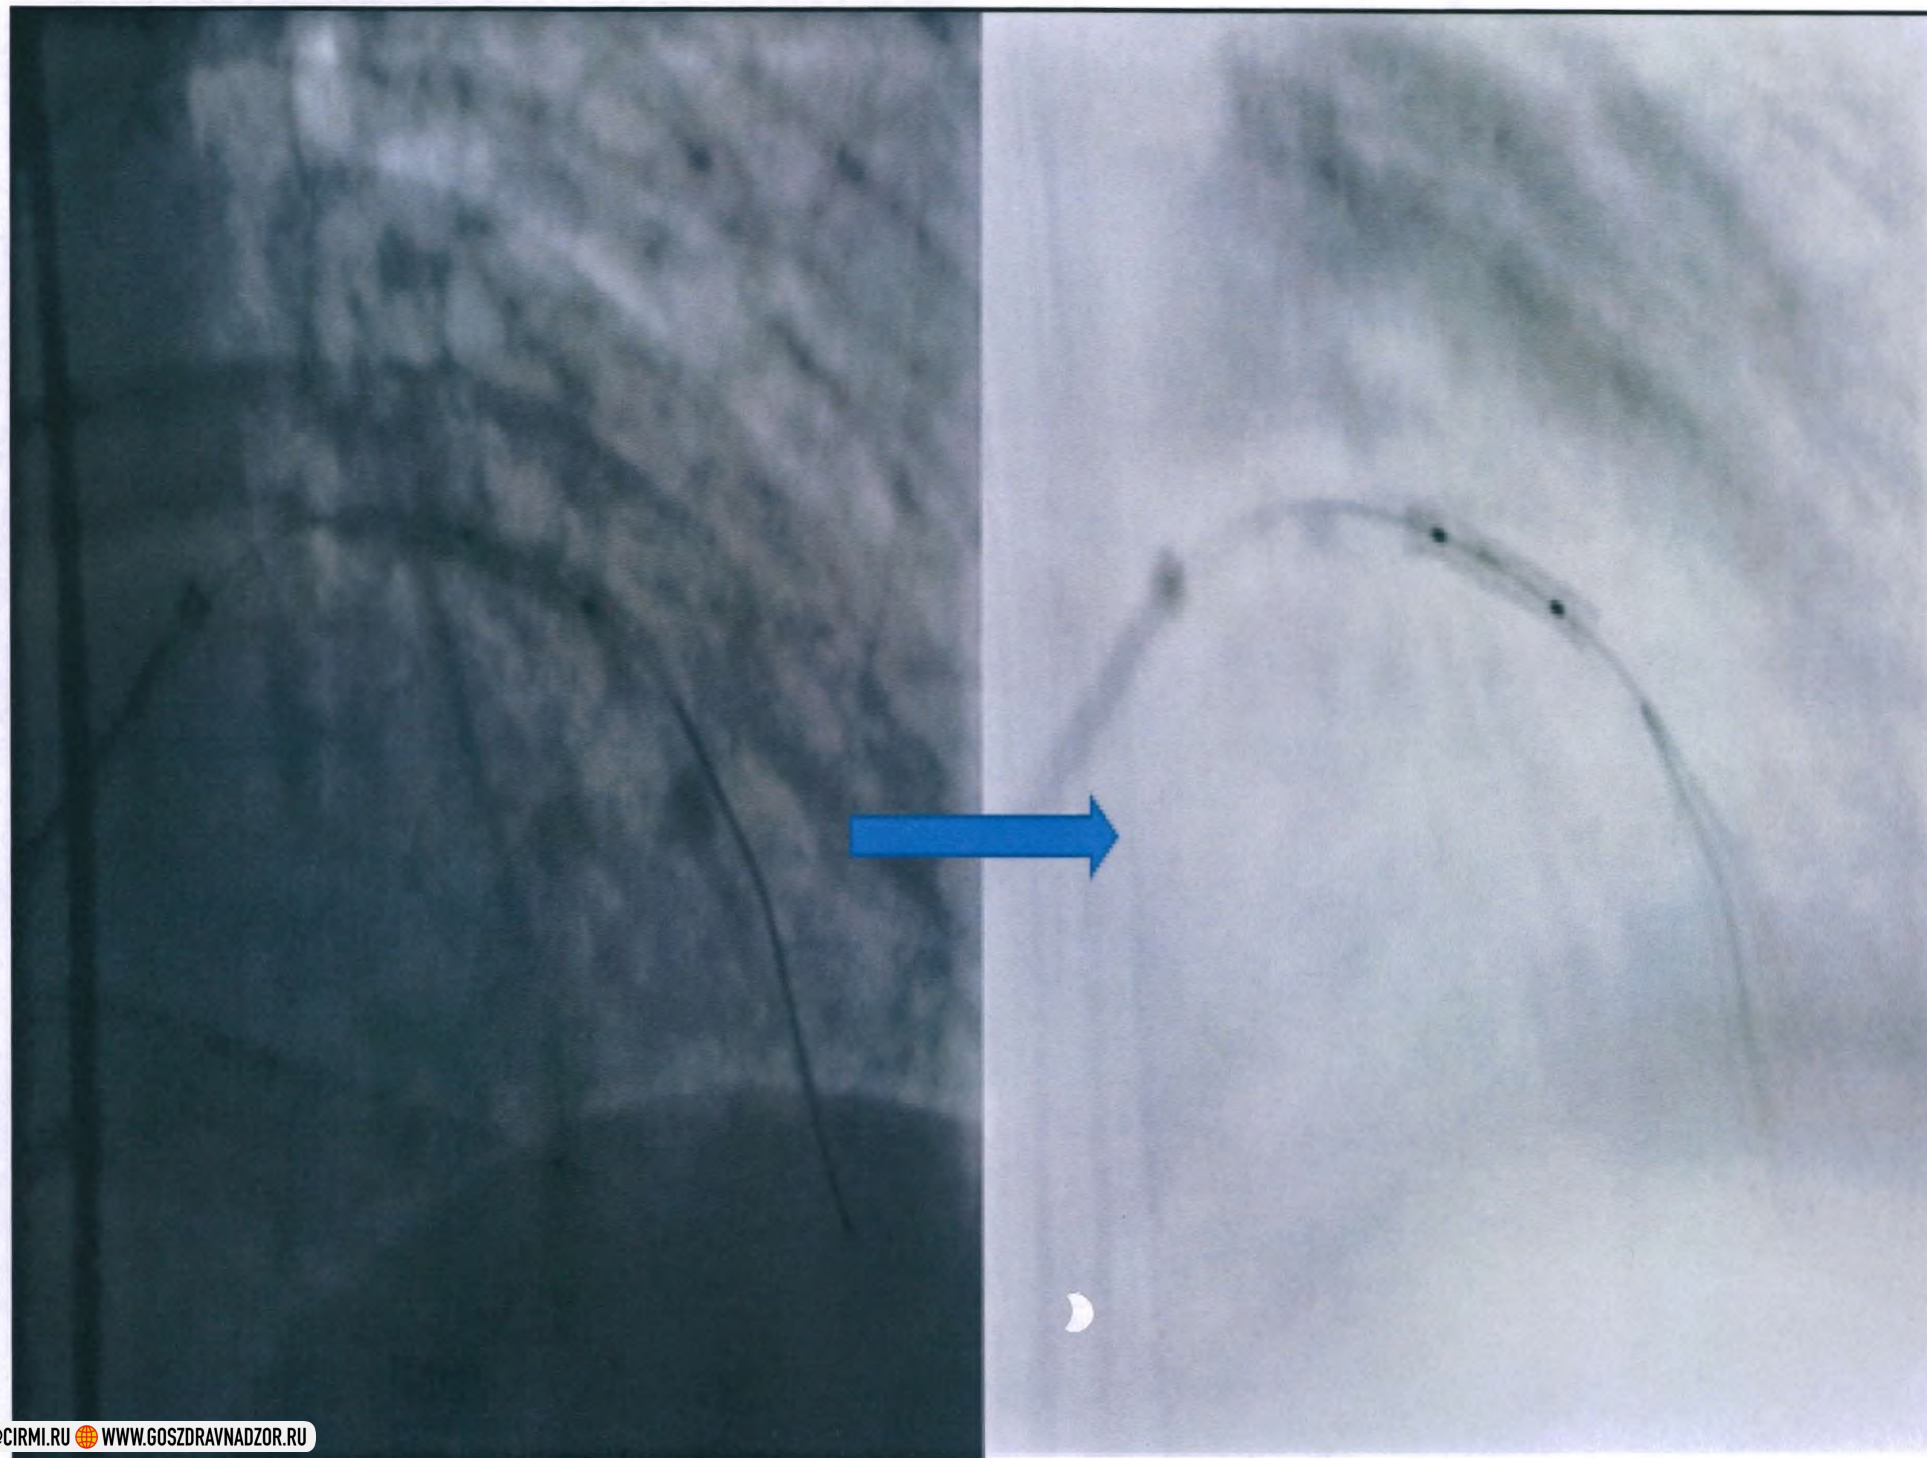

46. Монитор 19-дюймовый или монитор 34-дюймовый, не более 5 шт.

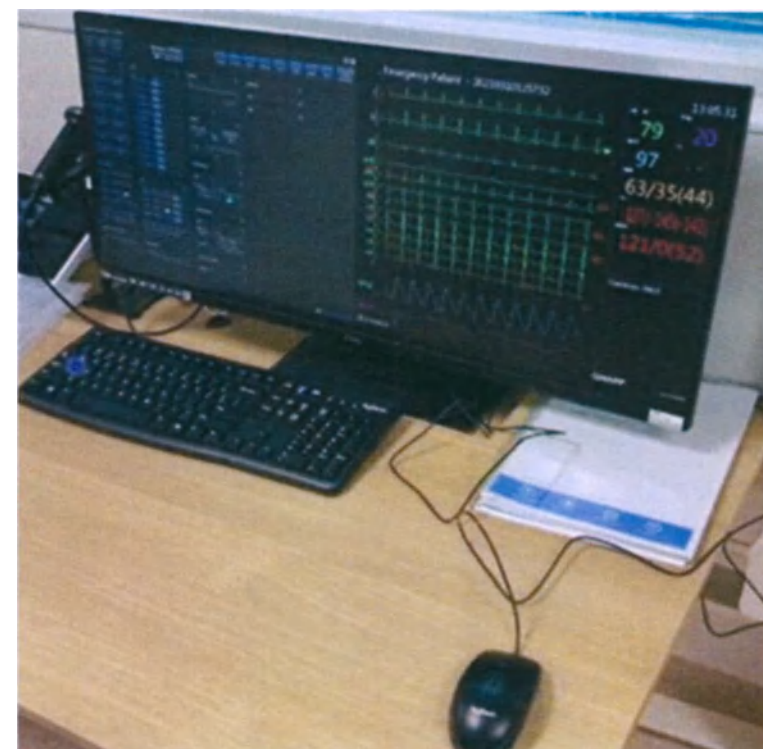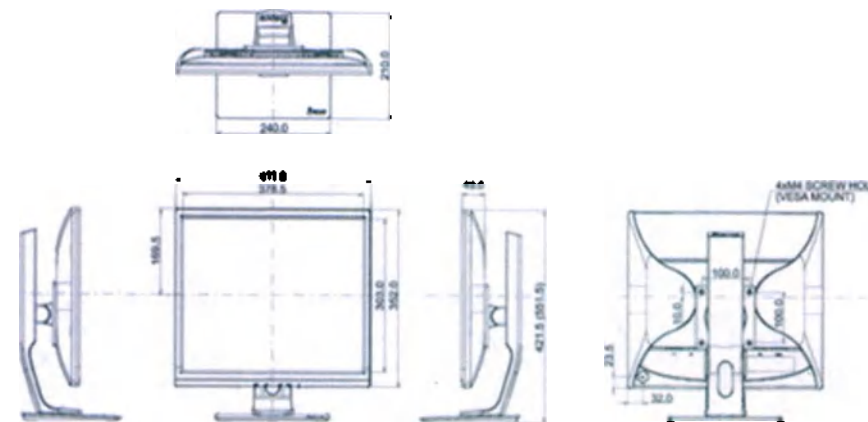



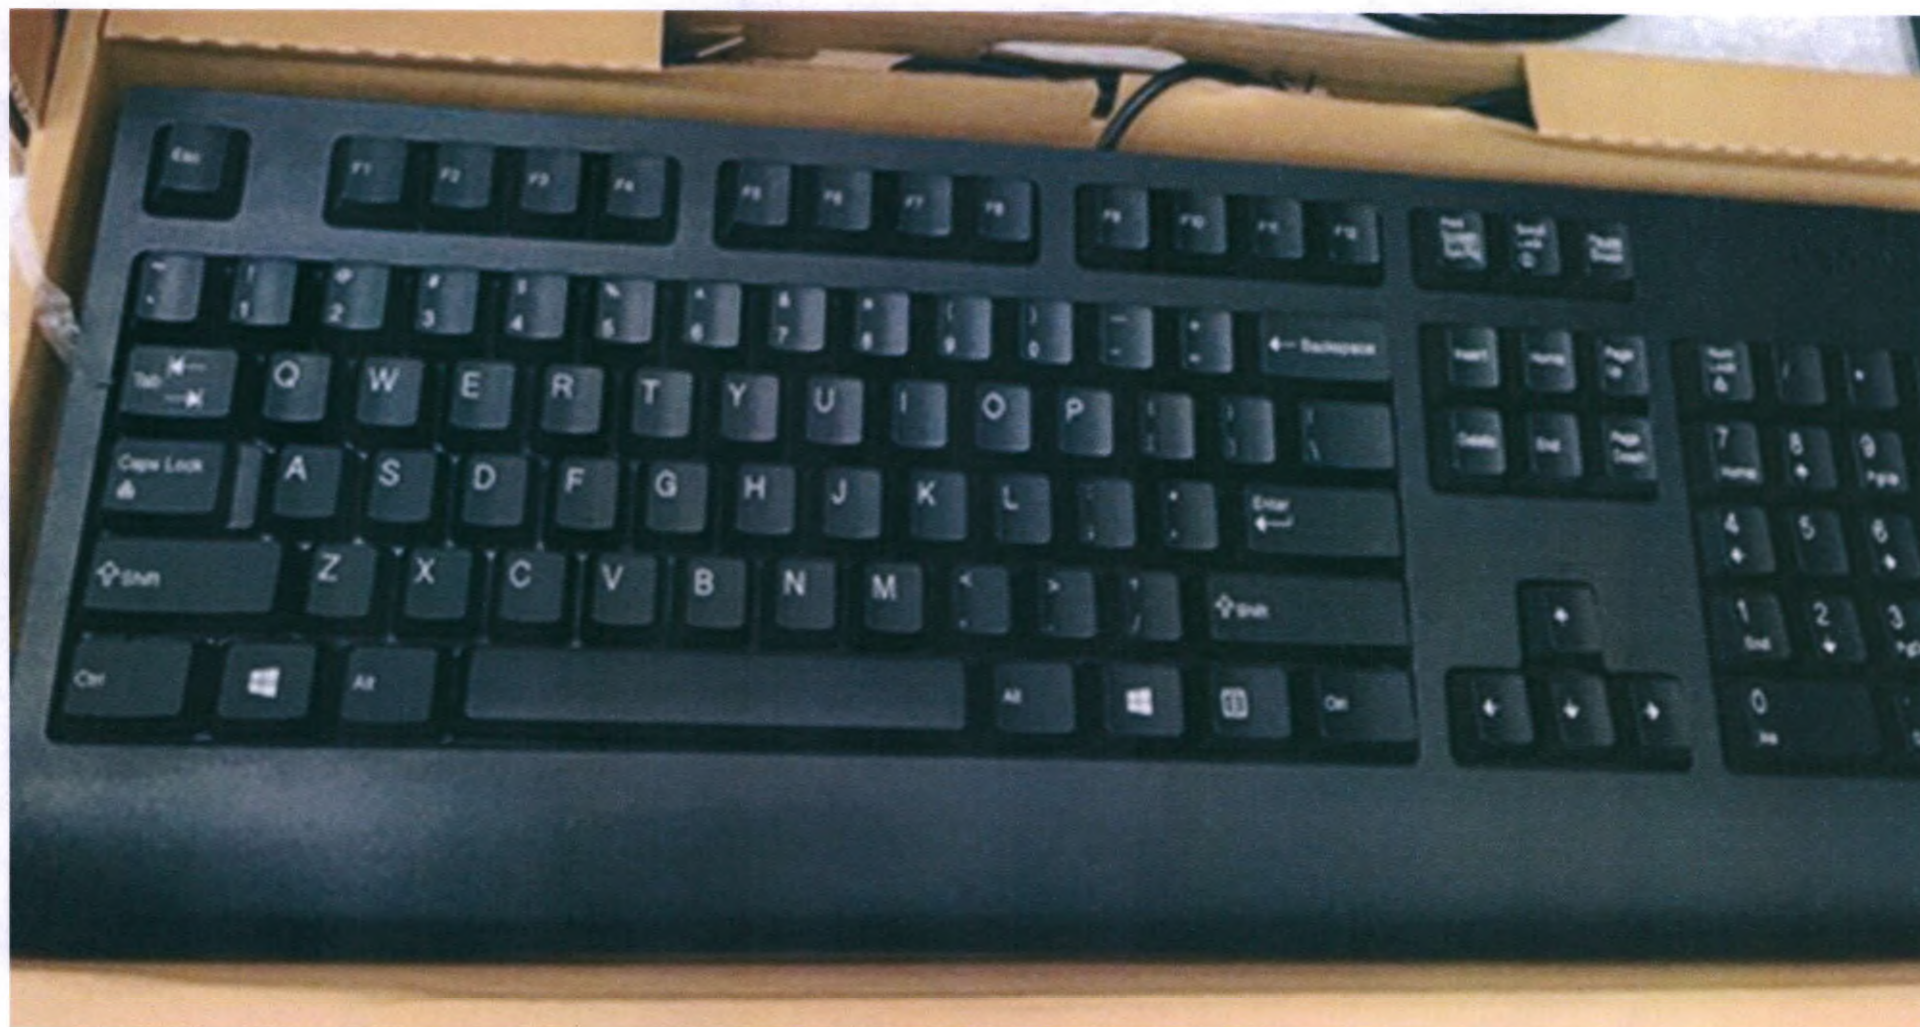





51. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоразовая NIBP, детская (оранжевая), 8-13 см



Манжета многоразовая NIBP, детская (зеленая), 12-19 см



Манжета многоразовая NIBP, маленькая, для взрослых (ярко-синяя), 17-25 см



Манжета многоразовая NIBP, для взрослых (серая), 23-33 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (серая), 28-40 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (бордовая), 40-55 см

51. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоразовая NIBP, набедренная (коричневая), 38-50 см

52. Кабель соединительный магистральный для ЭКГ, не более 6 шт.








Кабель для датчика инвазивного измерения давления, длина 320 см



Красный коннектор кабеля-удлинителя IBP к разъему с надписью IBP на усилителе QMAPP.

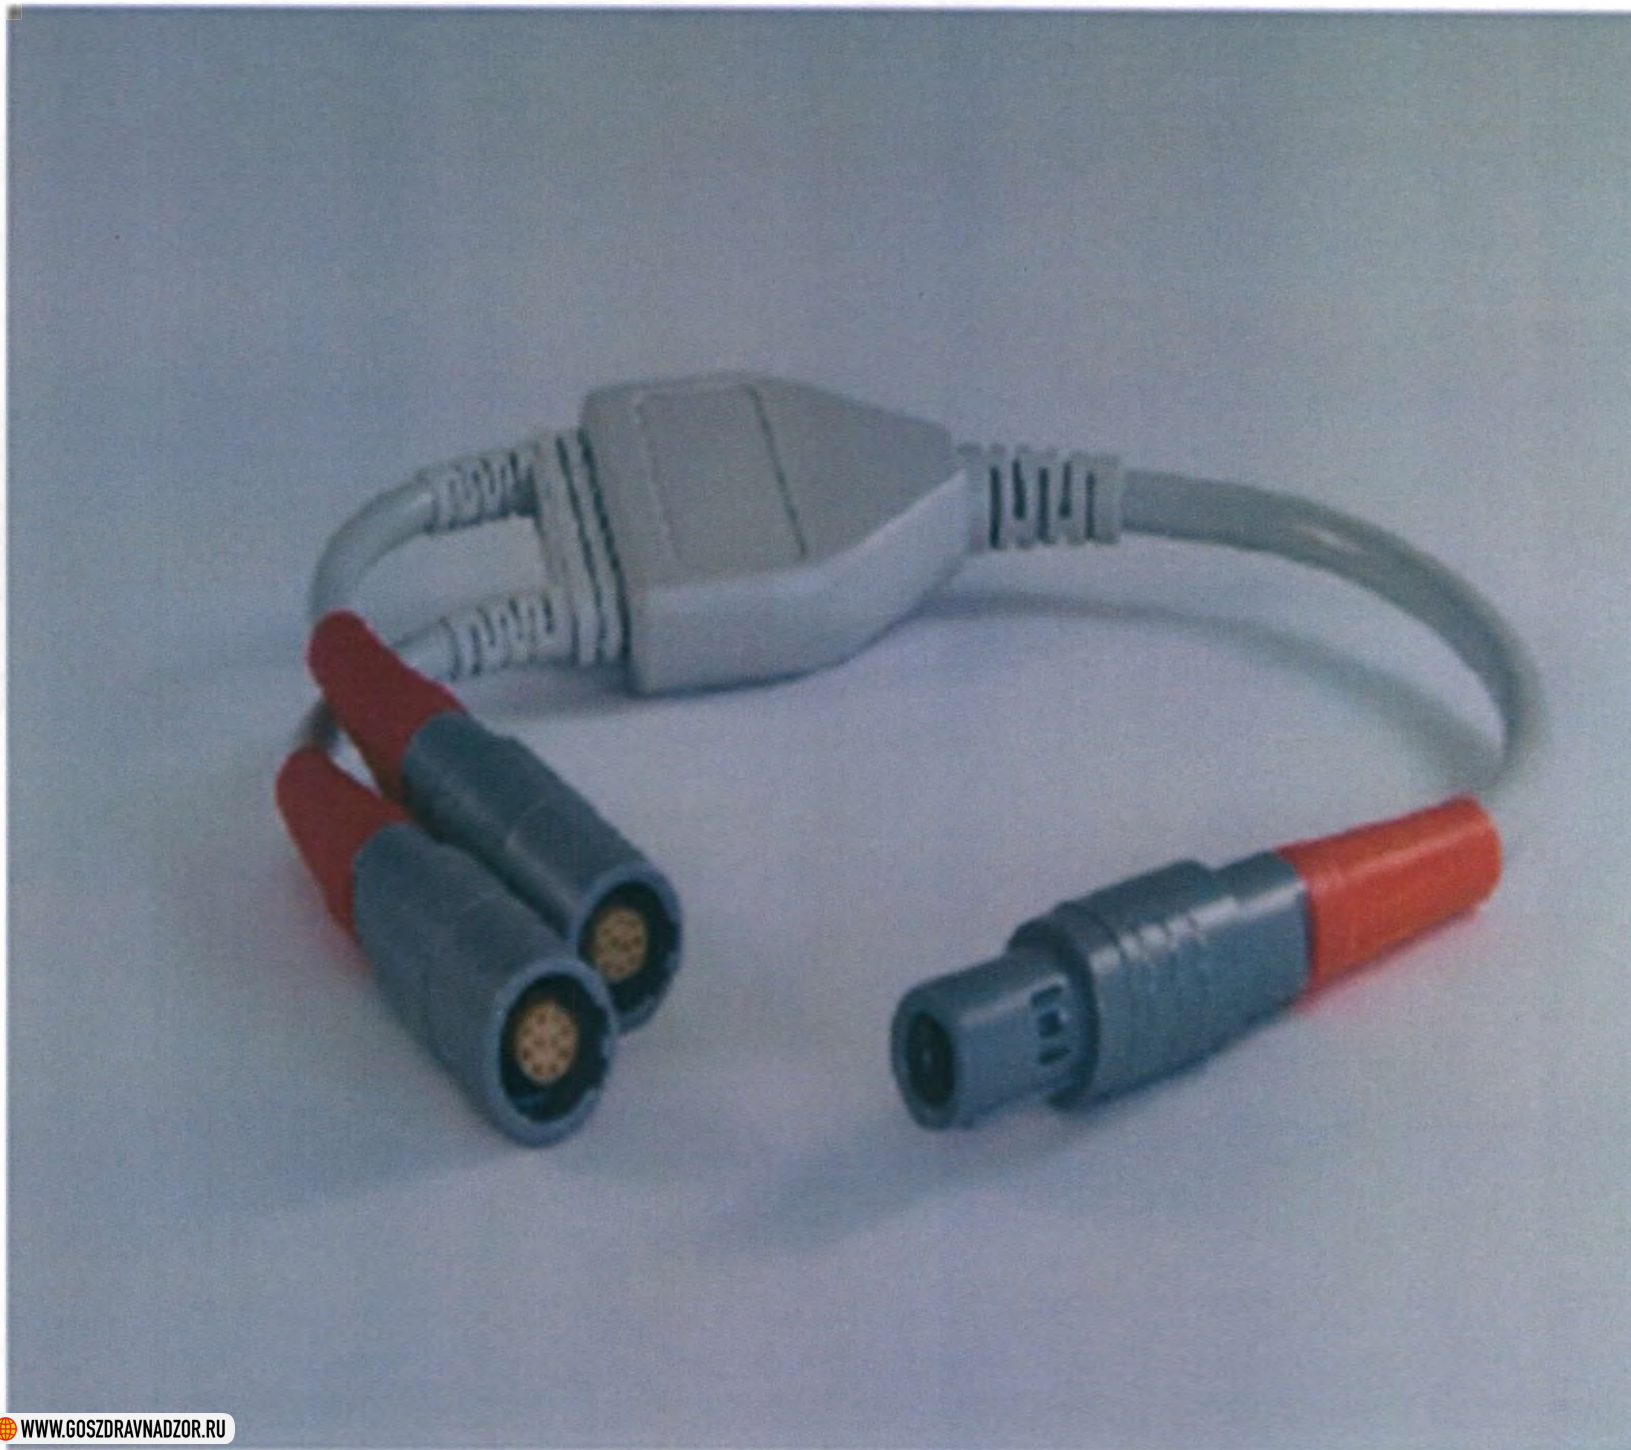




56. Модуль четырехканальный для ИВР.



57. Кабель соединительный для модуля IBP, не более 6 шт.



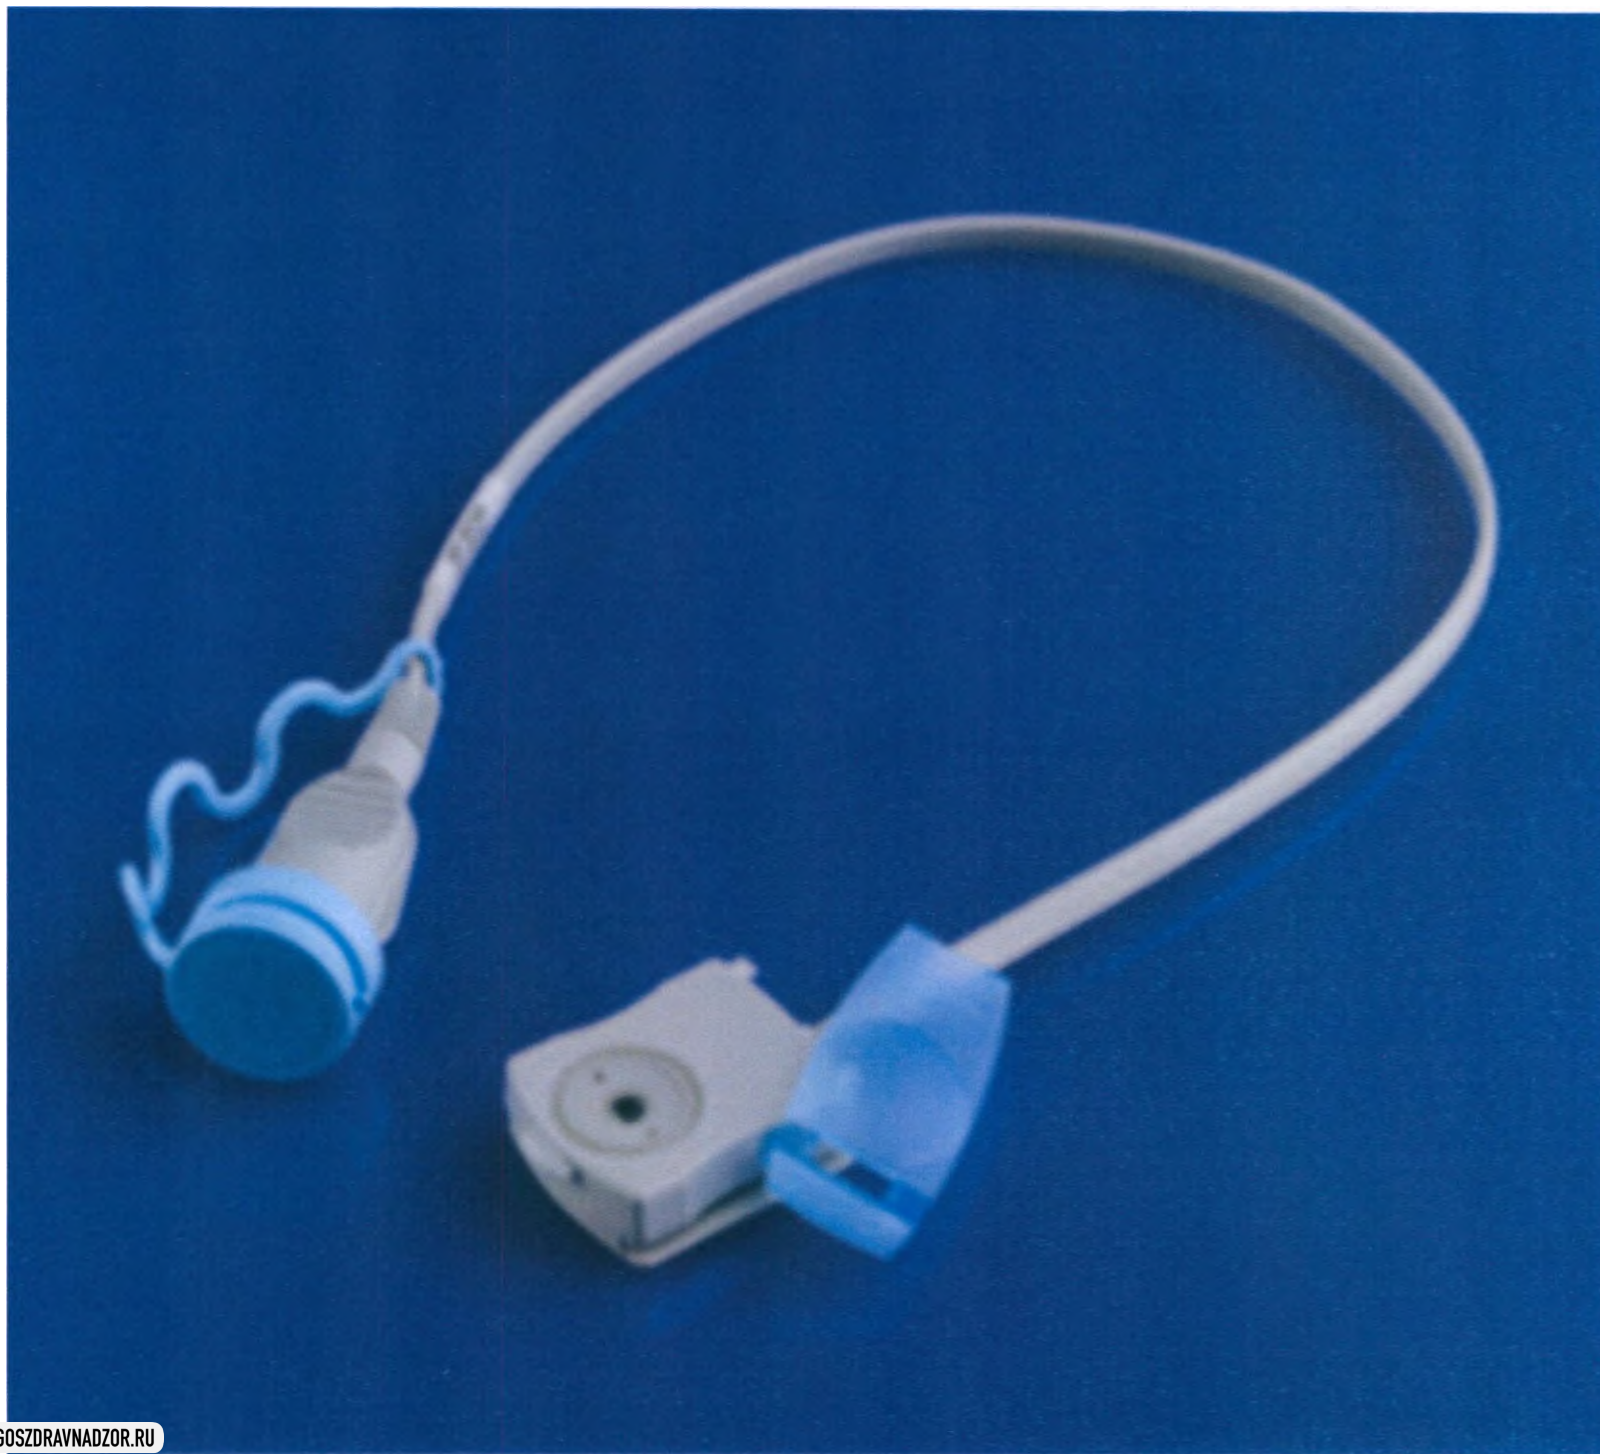

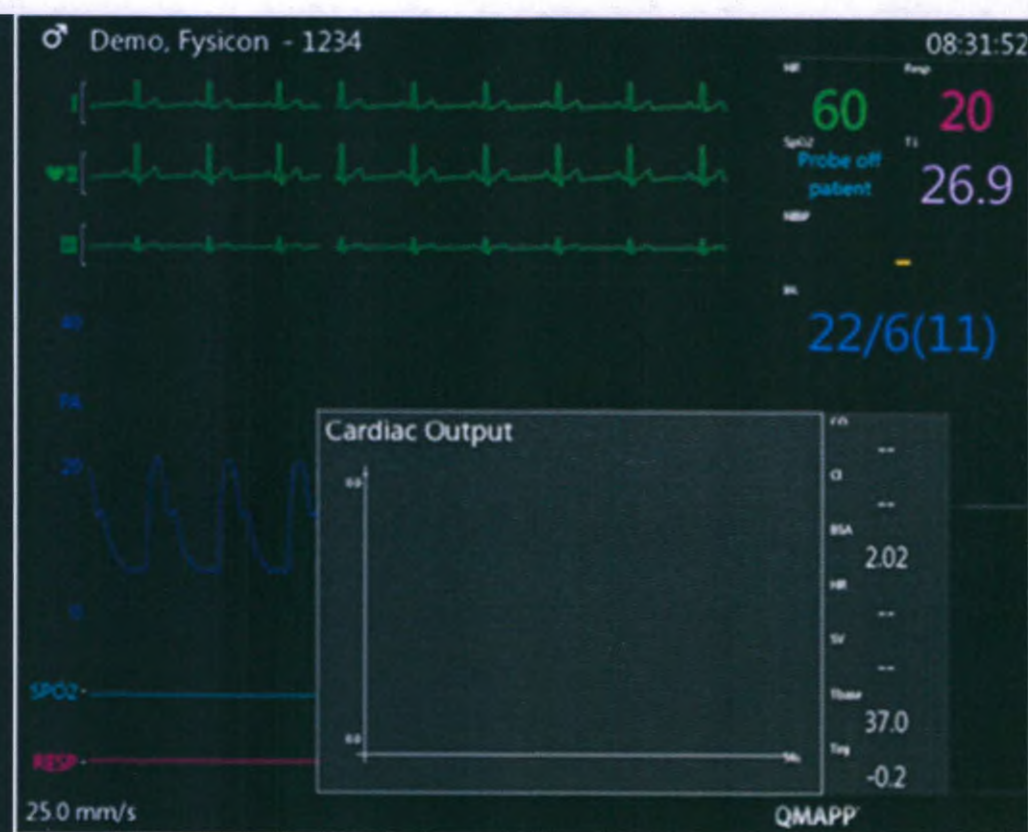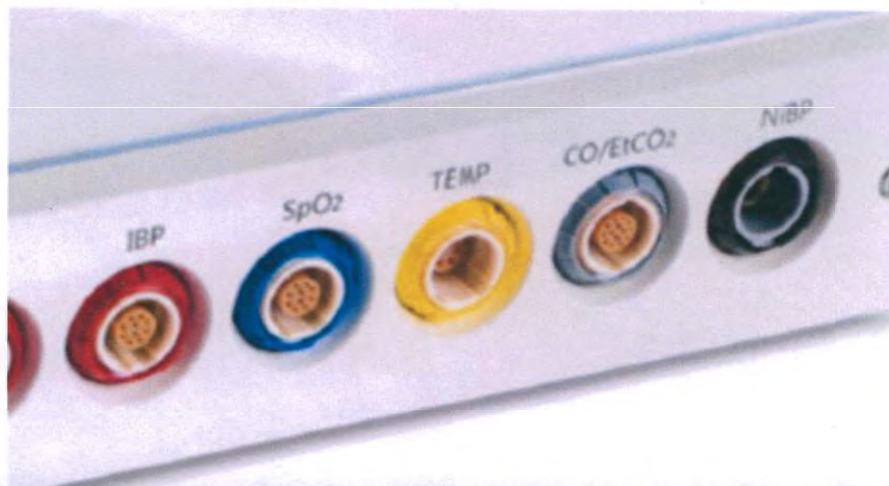

60. Комплект для измерения сердечного выброса методом термоделиции, в составе:- кабель для измерения сердечного выброса методом



60. Комплект для измерения сердечного выброса методом термодилуции, в составе:

- датчик для измерения сердечного выброса методом термодилуции, не более 2 шт.



61. Модуль для регистрации фракционного резерва кровотока.

FFR 

Mode: **Monitoring** ▼

Channel:

Pa
(AO pressure) ▼

Pd
(AOPd pressure wire) ▼

Averaging: **Short** ▼

Equalize

Record FFR

FFR 

Mode: **Measurement** ▼

Channel:

Pa
(AO pressure) ▼

Pd
(AOPd pressure wire) ▼

Averaging: **Middle** ▼

Equalize

Record FFR

62. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.



Кабель типа 6.3 мм «Моно Jack» для «Volcano i5», длина 320 см



Кабель для регистрации давления для «Volcano», длина 320 см



Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:



Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:

Кабель Pd к Boston

62. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.



кабель Abbot длиной 65 см






кабель Abbot длиной 320 см



кабель для Abbot Wibox длиной 320 см

63. Блок для регистрации фракционного резерва кровотока

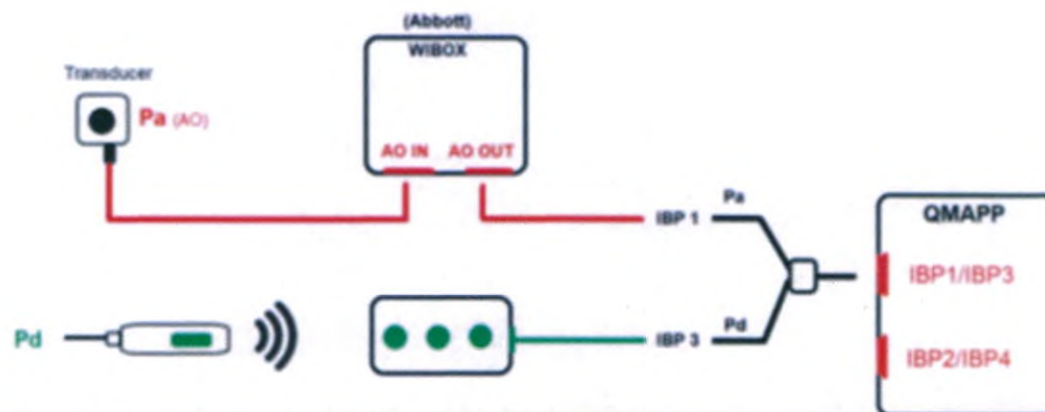

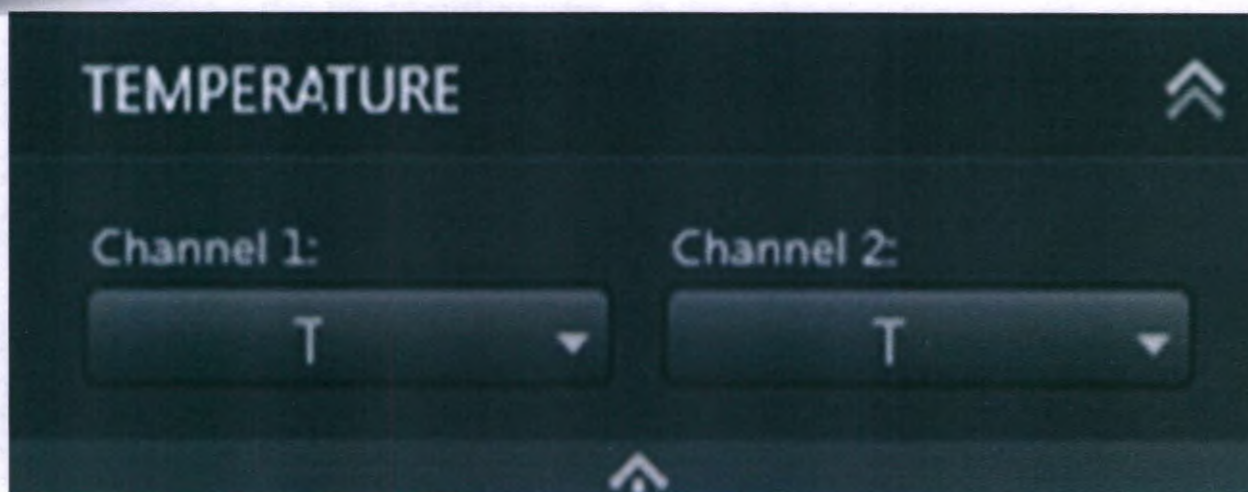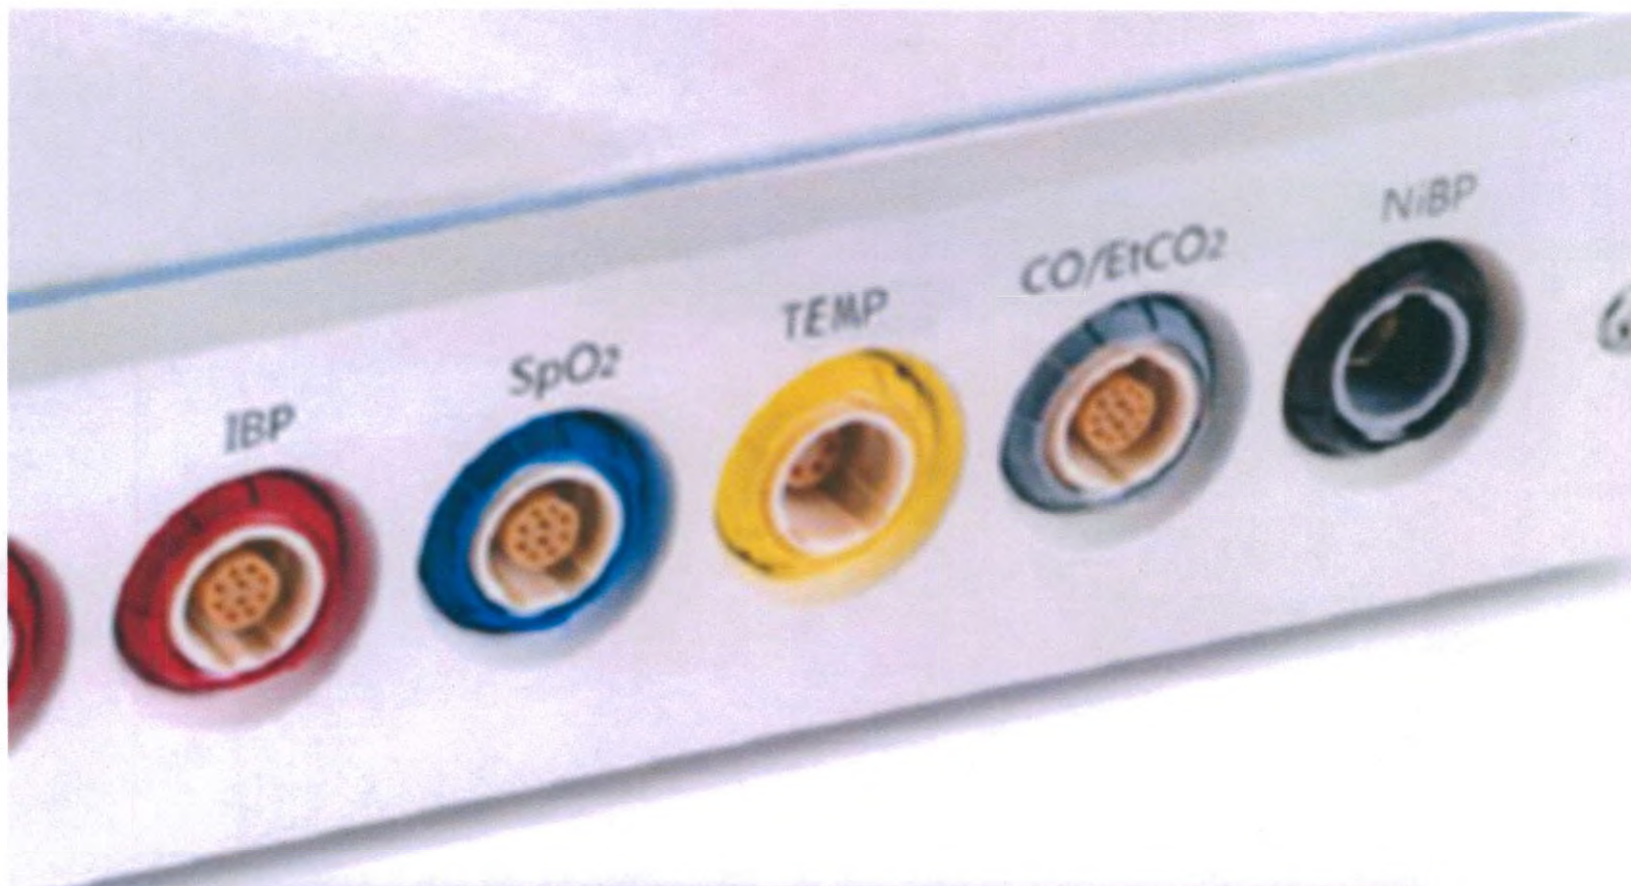





ETCO₂

Wave On

Sweep Speed: 6.25 mm/

Balance Gas: Room air

Barometric Pressure (mmHg): 760


O₂ Compensation (%): 16


Anesthetic Agent (%): 0

Averaging: 1 breath

Zero

67. Линия EtCO₂, не более 3 шт.

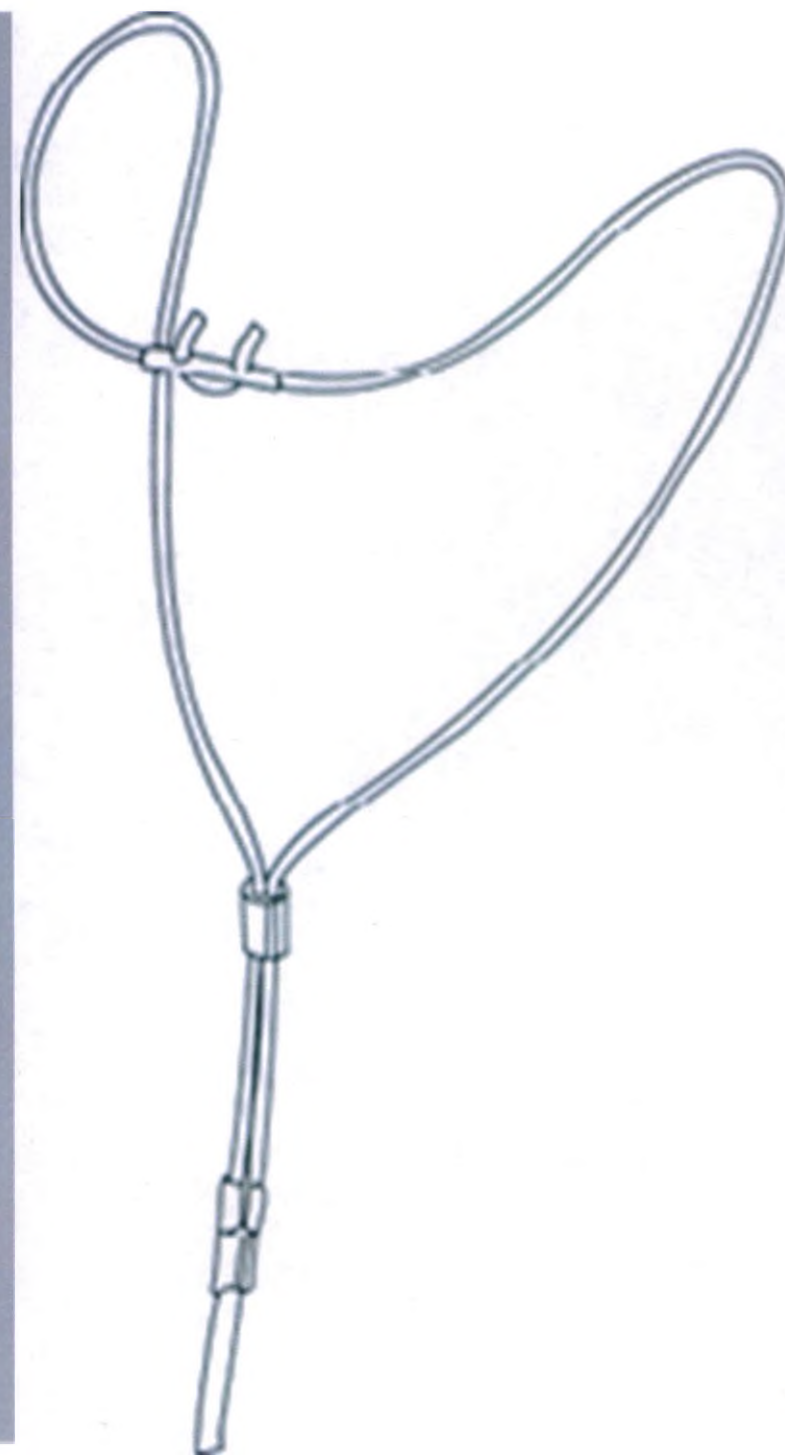

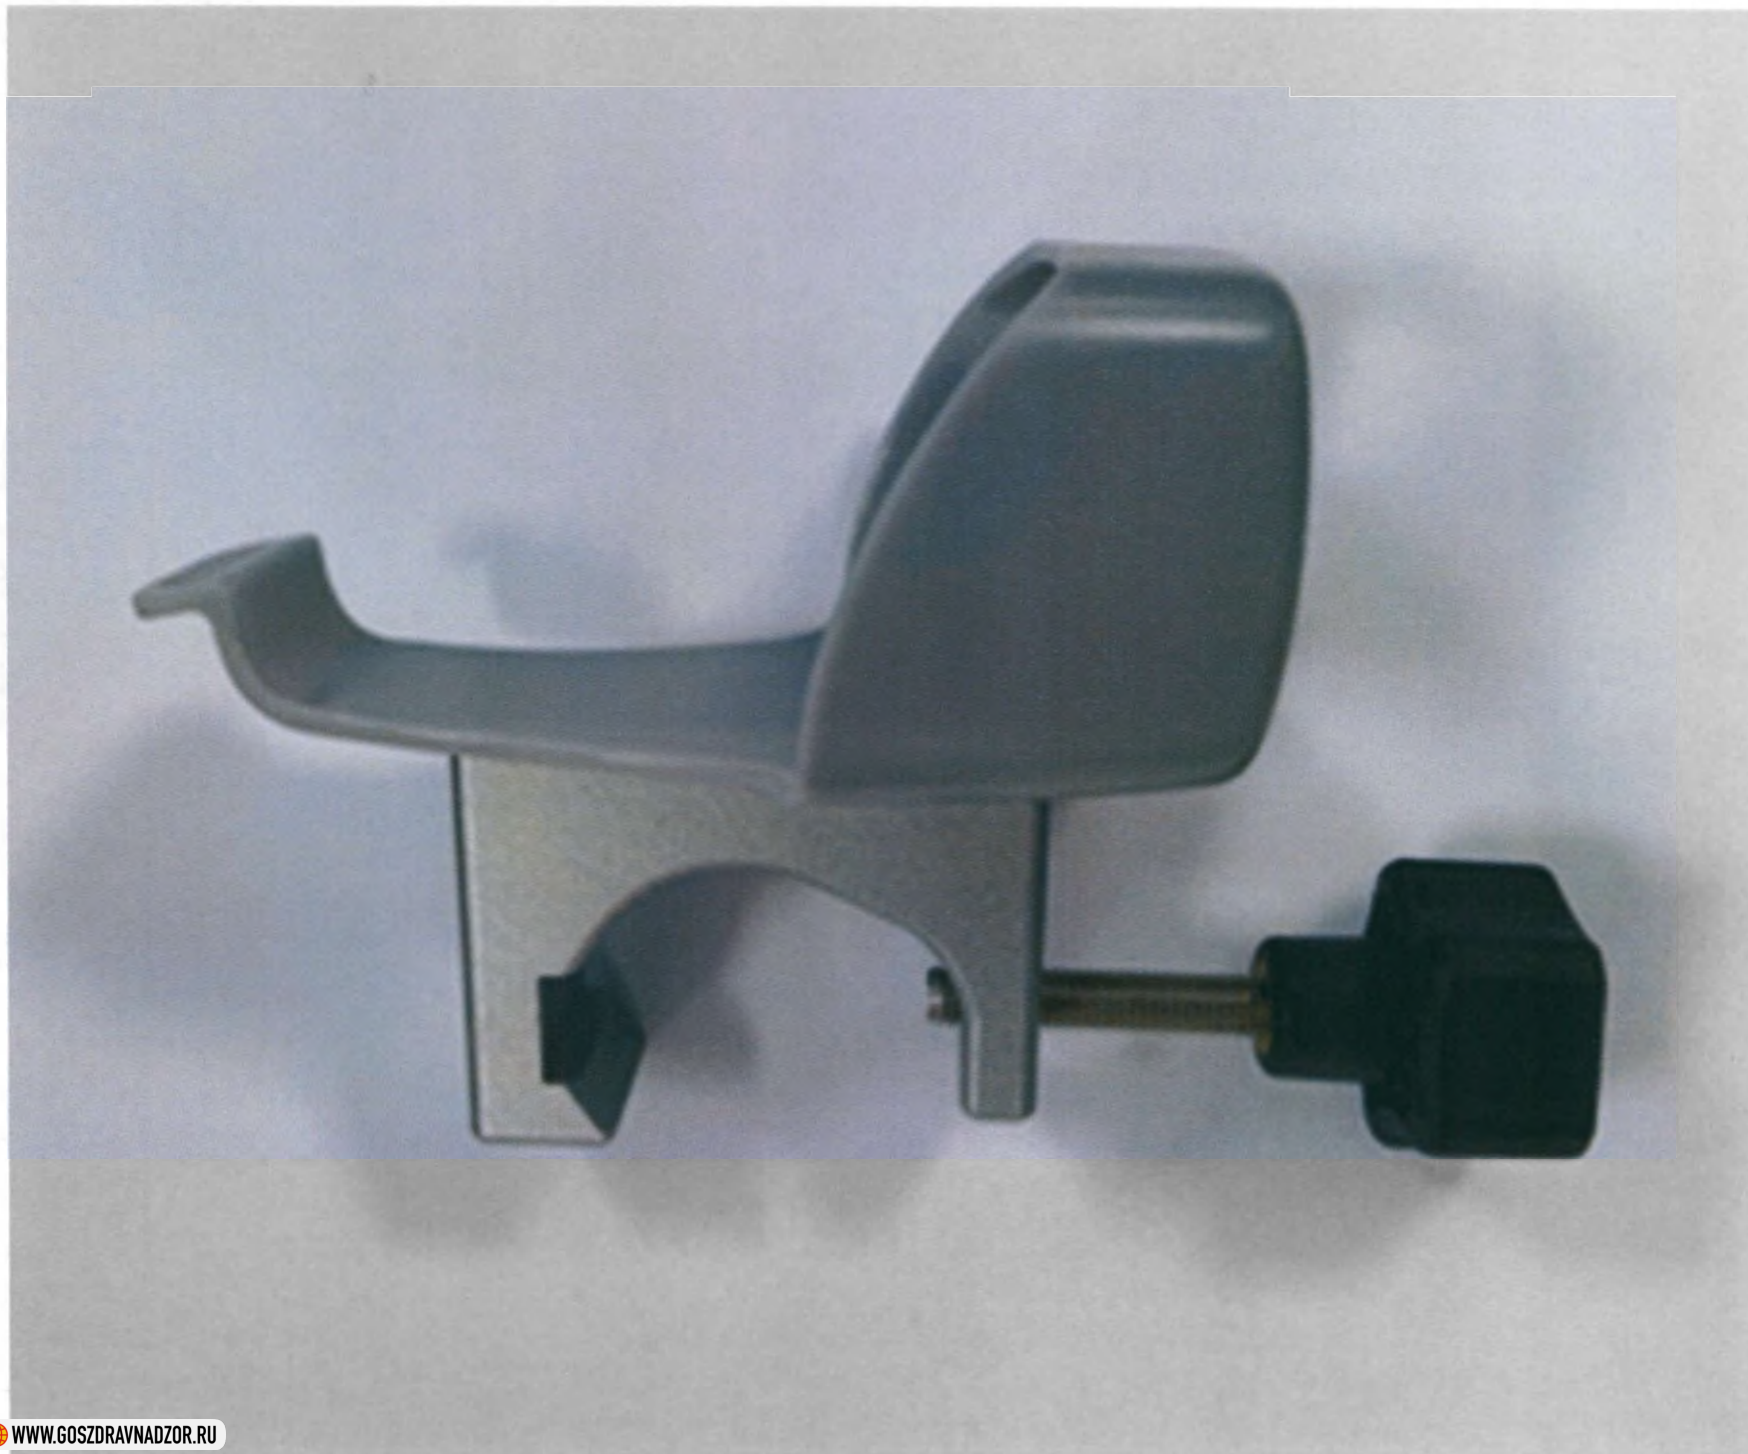

69. Датчик температурный, не более 5 шт.



Датчик кожный, многоразовый для взрослых



Датчик ректальный многоразовый для взрослых.

69. Датчик температурный, не более 5 шт.




Датчик центральный многоразовый для взрослых

70. Кабель соединительный для температурных датчиков, не более 3 шт.



71. Кабель для выходного сигнала AUX, не более 3 шт.

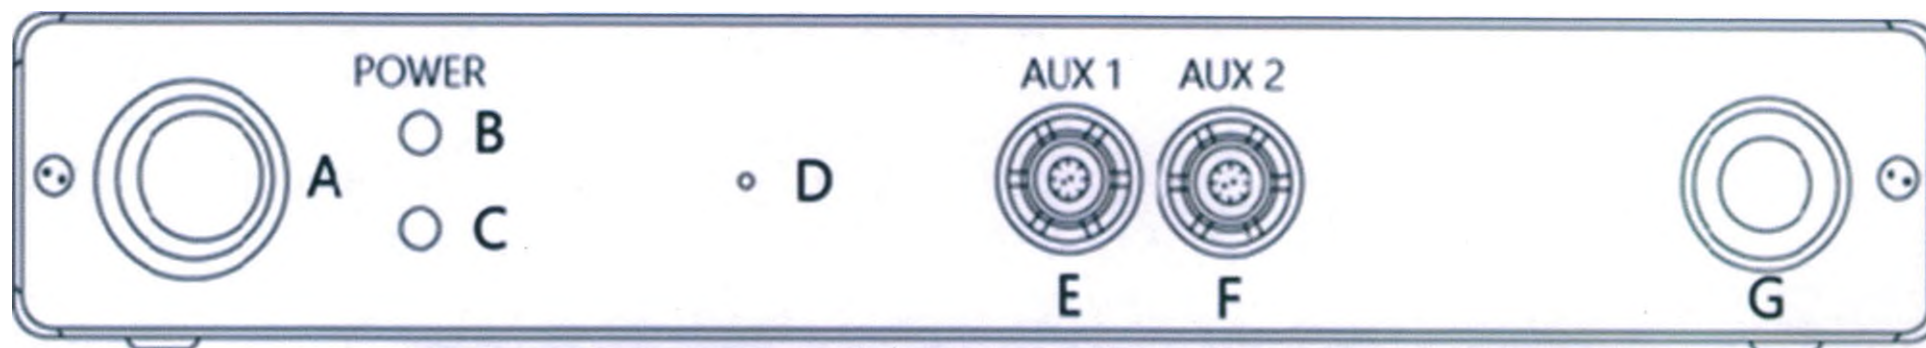




73. Датчик многоразовый SpO₂, не более 3 шт.



74. Кабель для неинвазивного измерения давления, не более 3 шт.



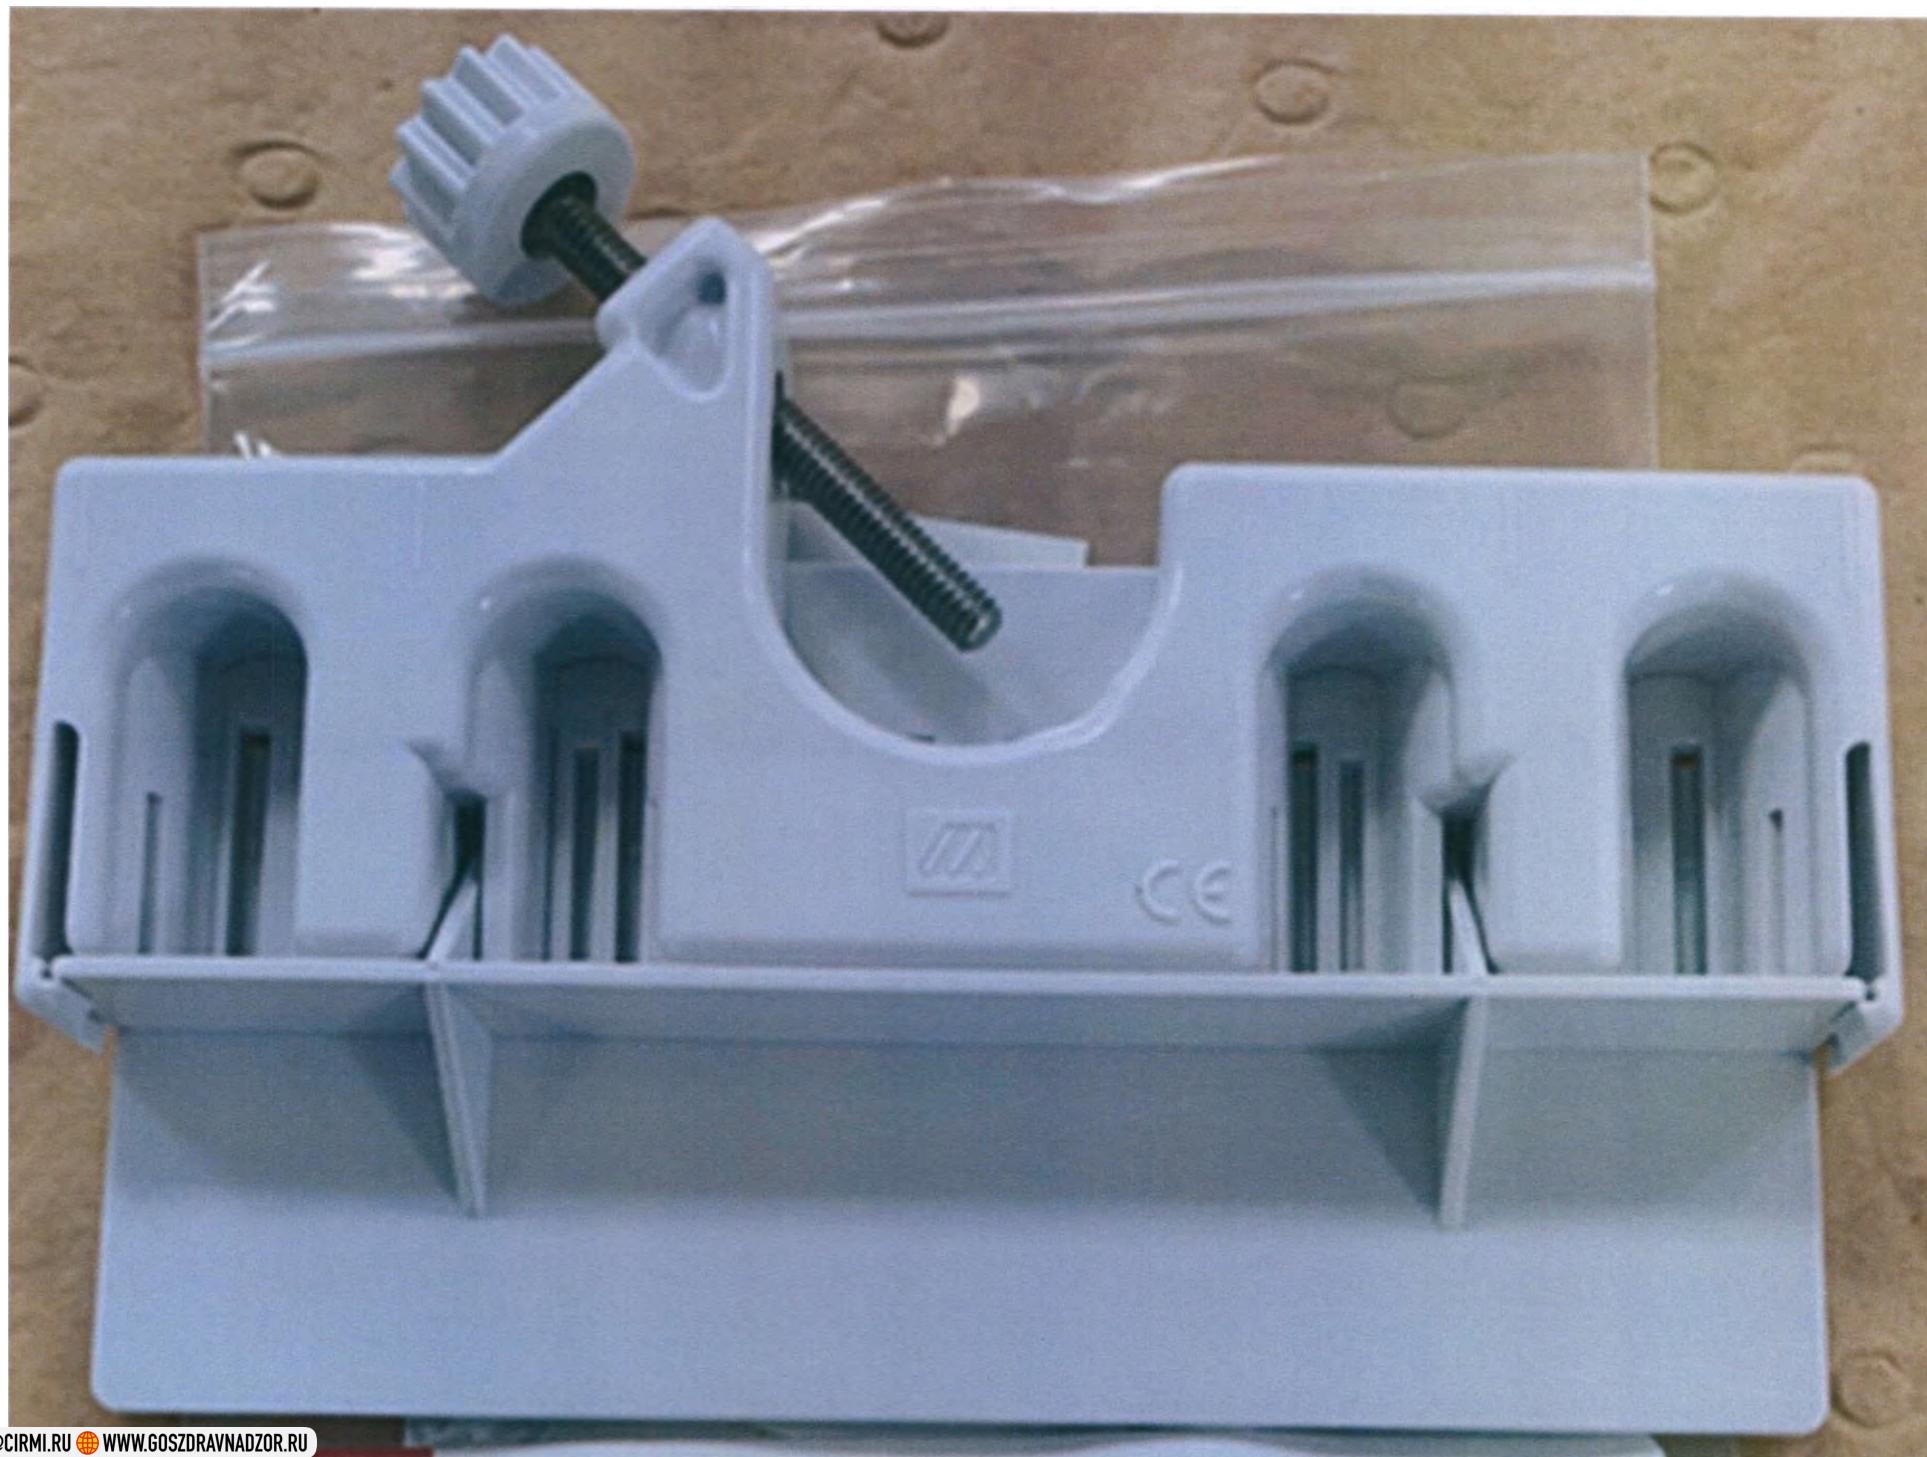

76. Комплект для вывода внешнего сигнала.







79. Монитор с большим экраном (для цифрового вывода, 48 портов).



Монитор



Многоэкранный сетевой компоновщик



Сенсорный интерфейс пользователя



Коммутатор Summit x670-48x




Кодировщик MNA-120ENC-DVI

80. Цифровое кодирующее устройство для добавления двух входных каналов DVI.



81. Комплект принадлежностей для большого монитора (система видеопередачи для операционной).

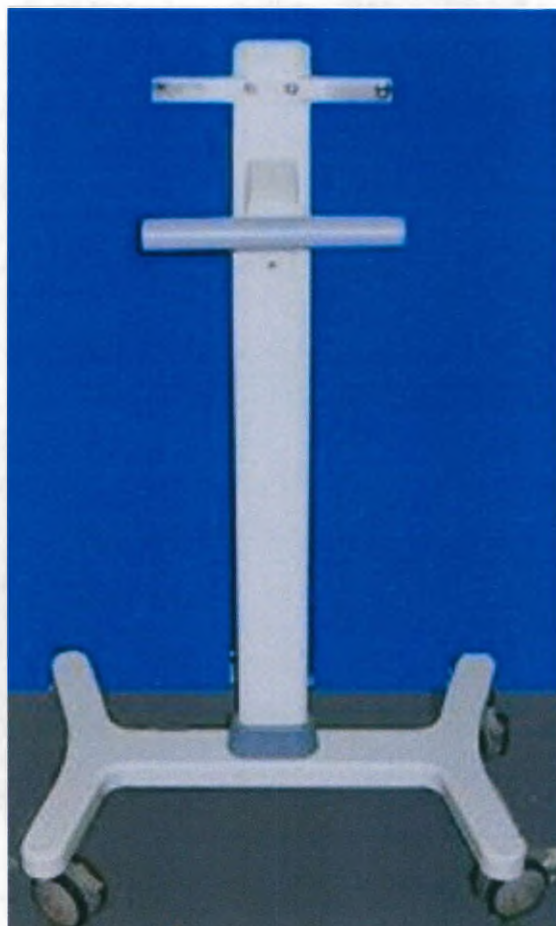

Подставка



Передатчик DVI 1



Передатчик DVI 2




Блок питания для монитора с большим экраном




Сетевой концентратор


82. Боковые направляющие для подвесного устройства для мониторов.

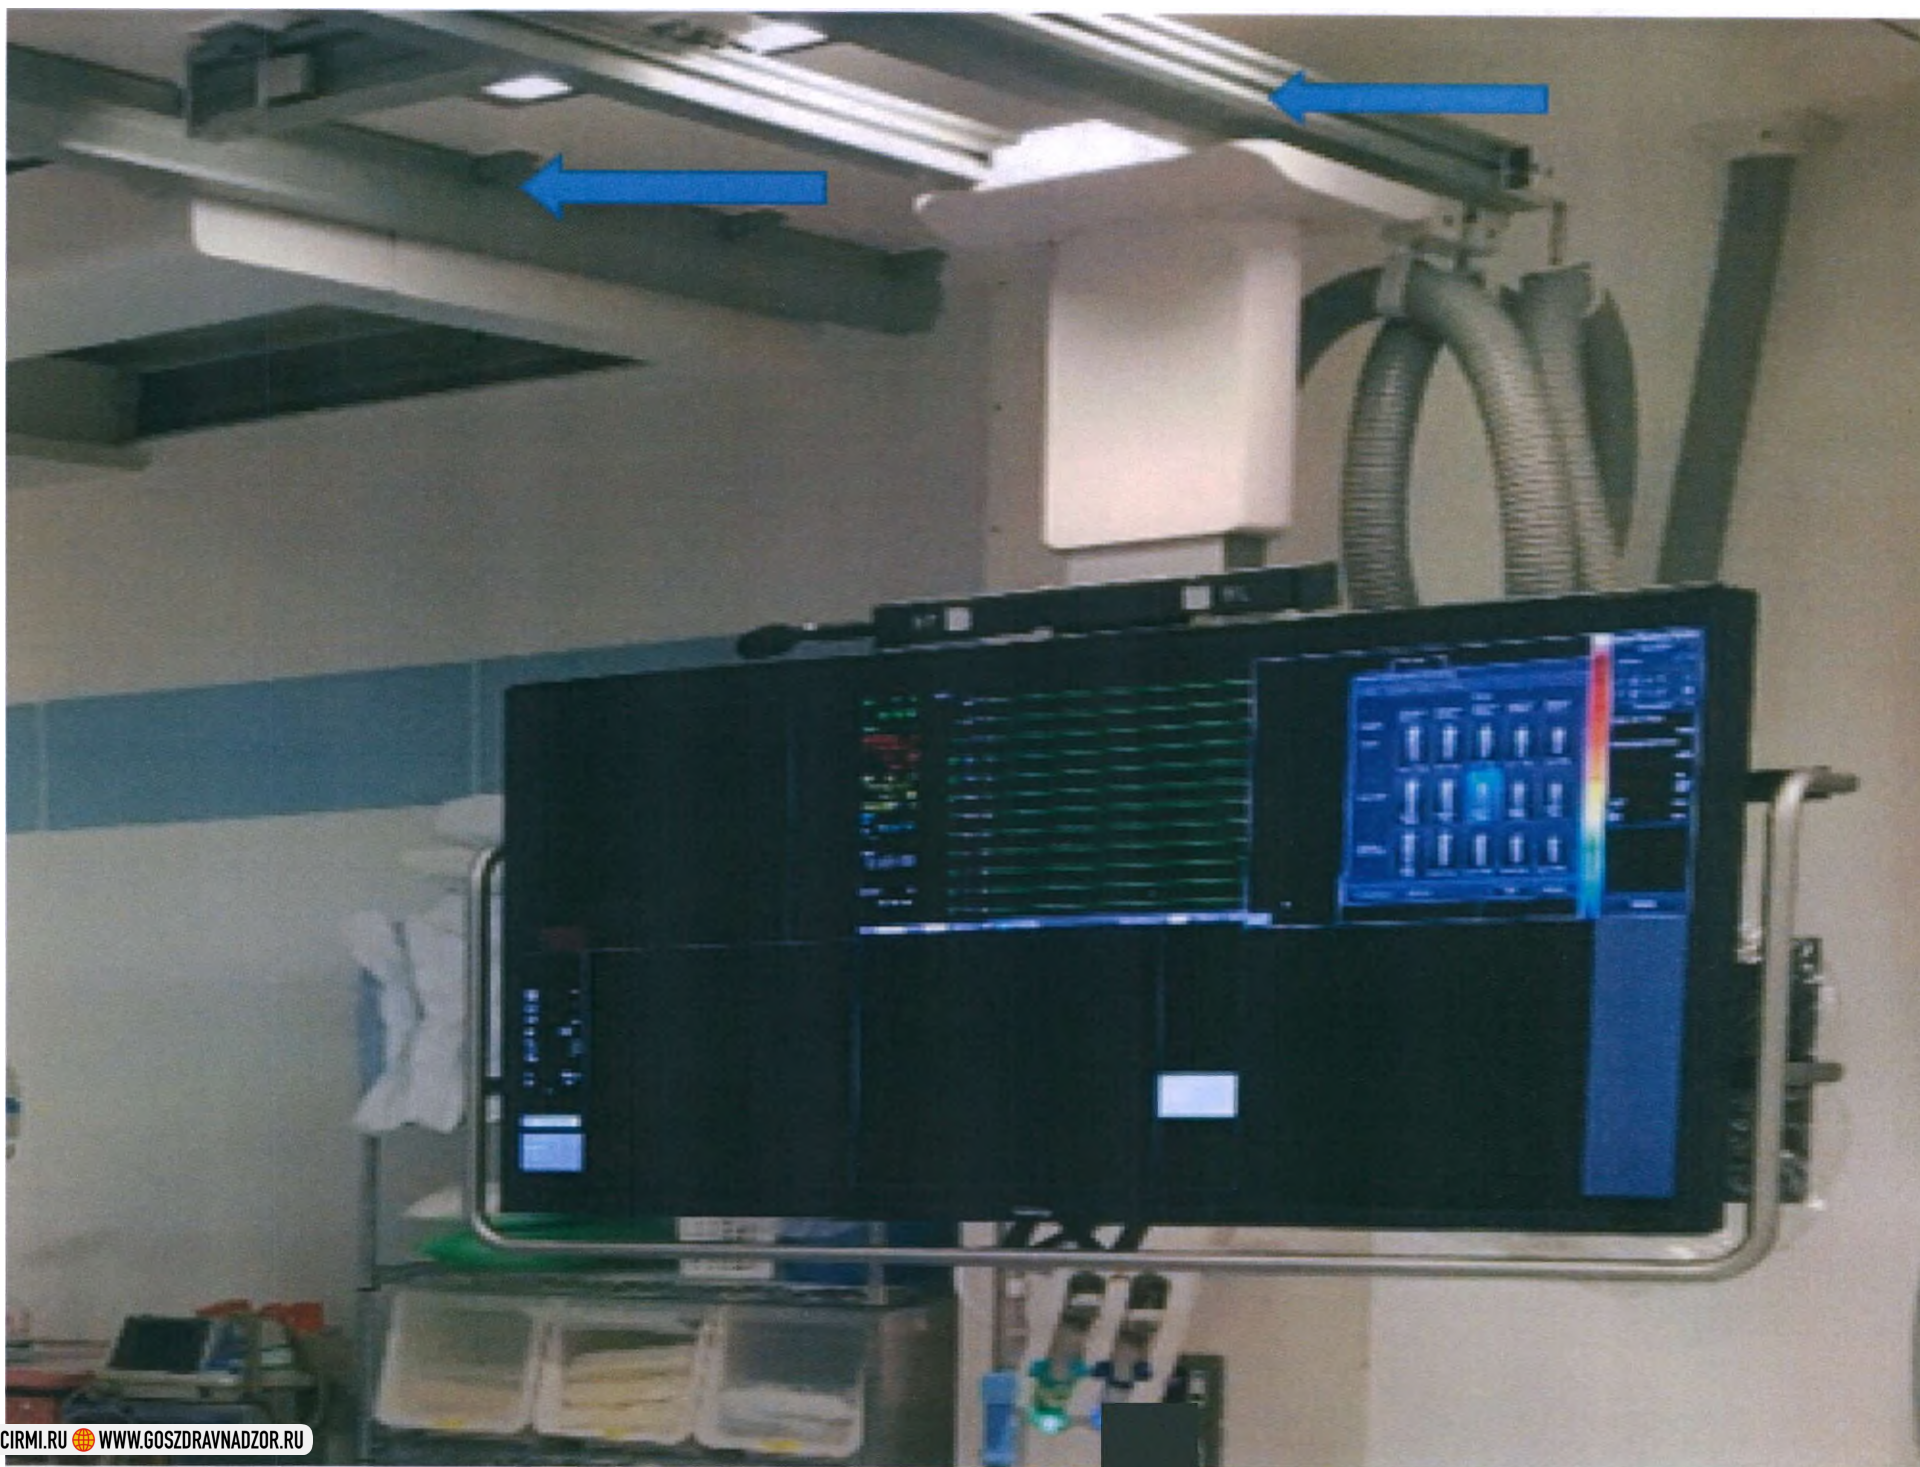

83. Комплект для защиты от магнитных полей (магнитный экран) для 8-дюймового FPD.

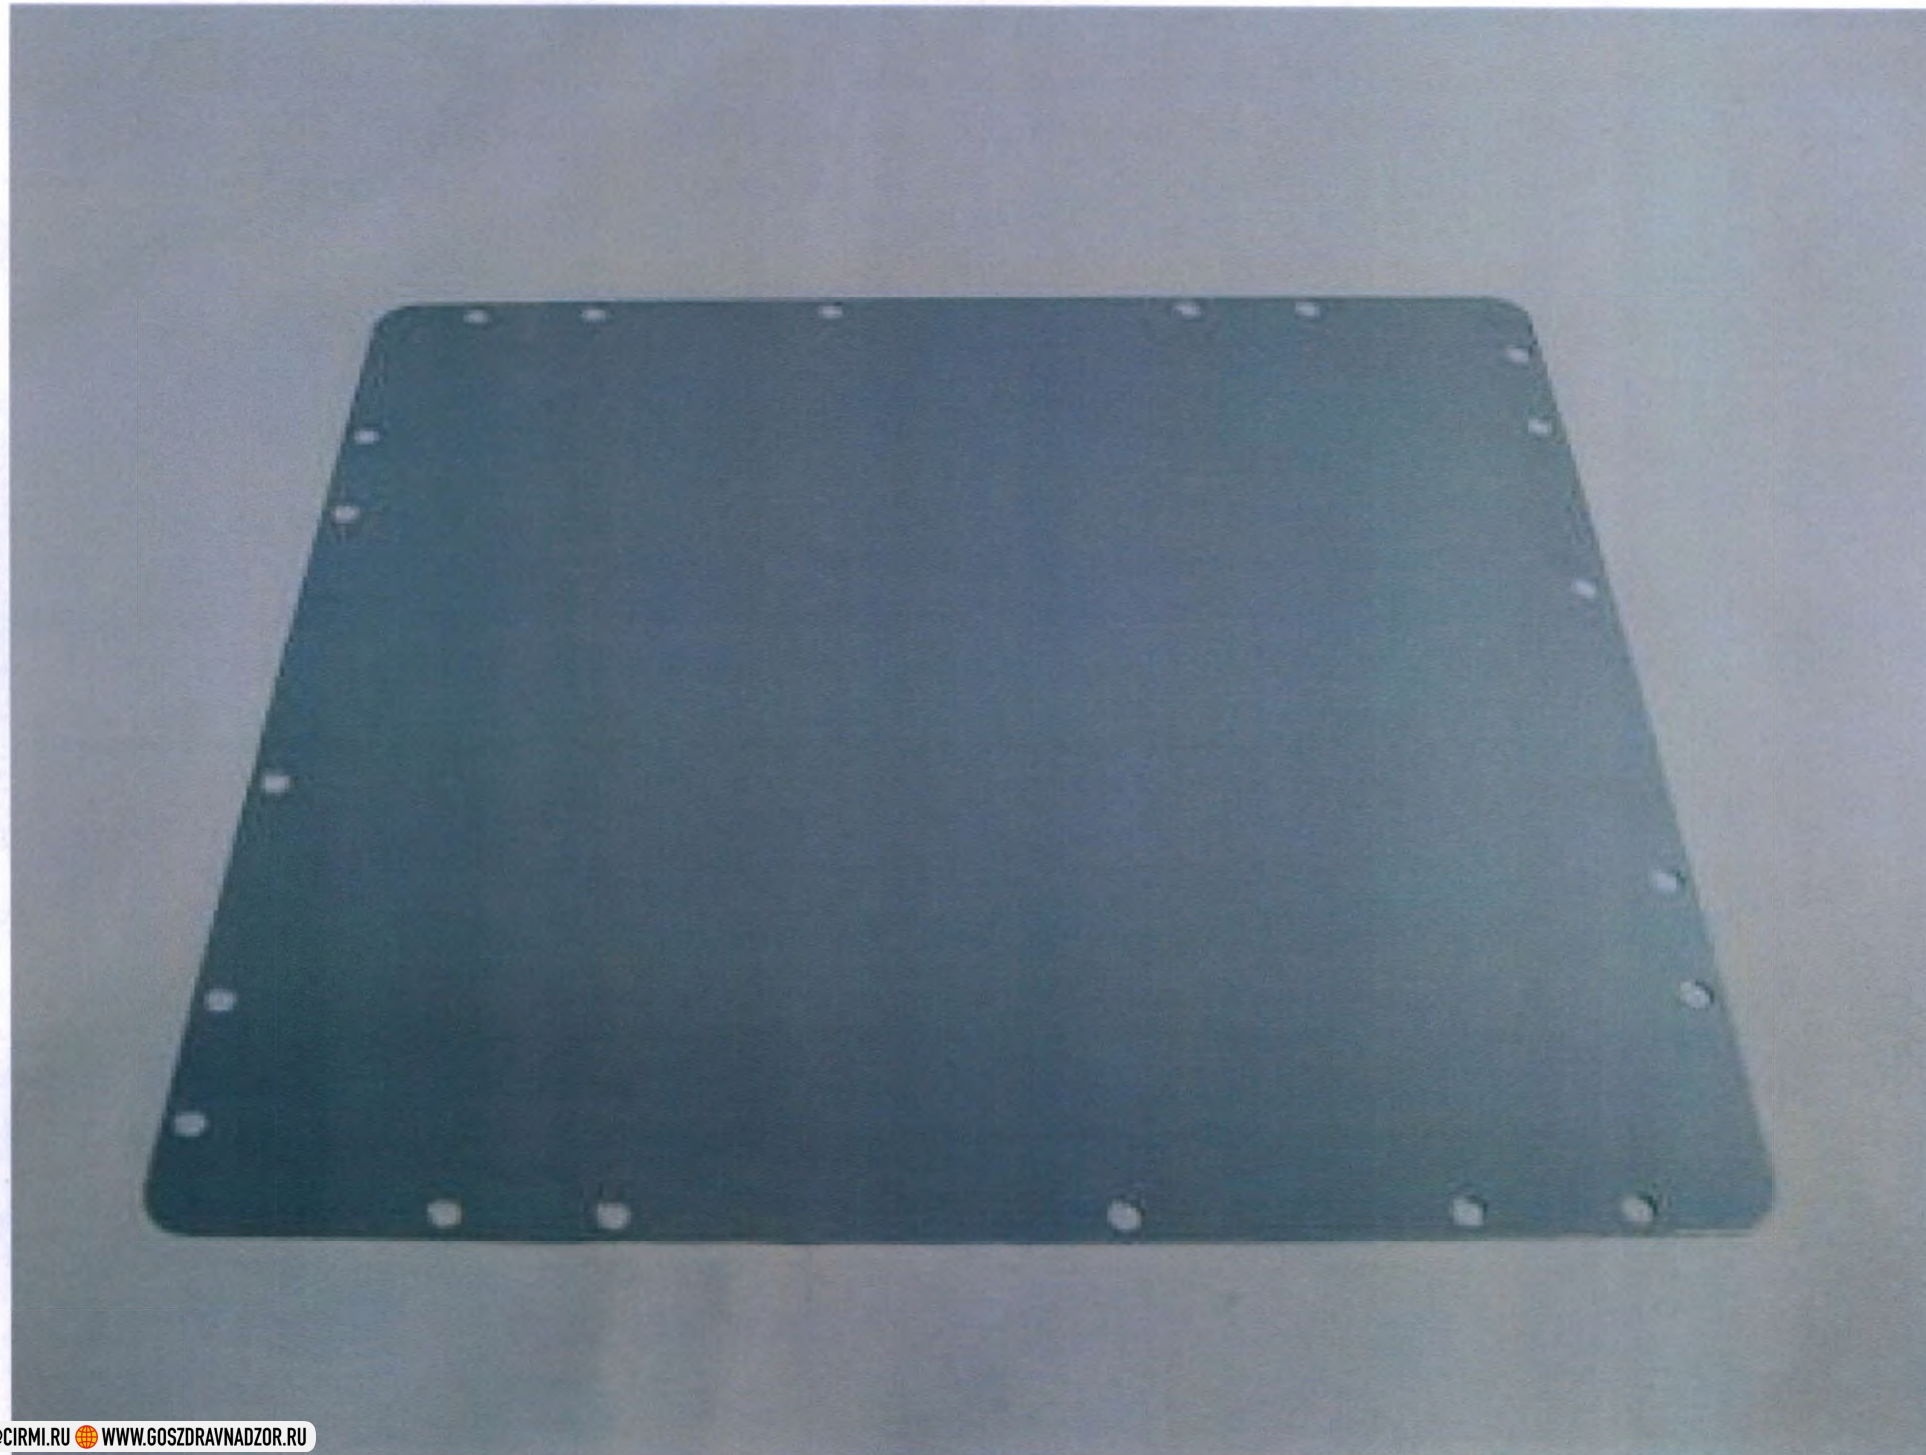


84. Комплект фиксатора поворота опорной колонны (для CAS-880A)

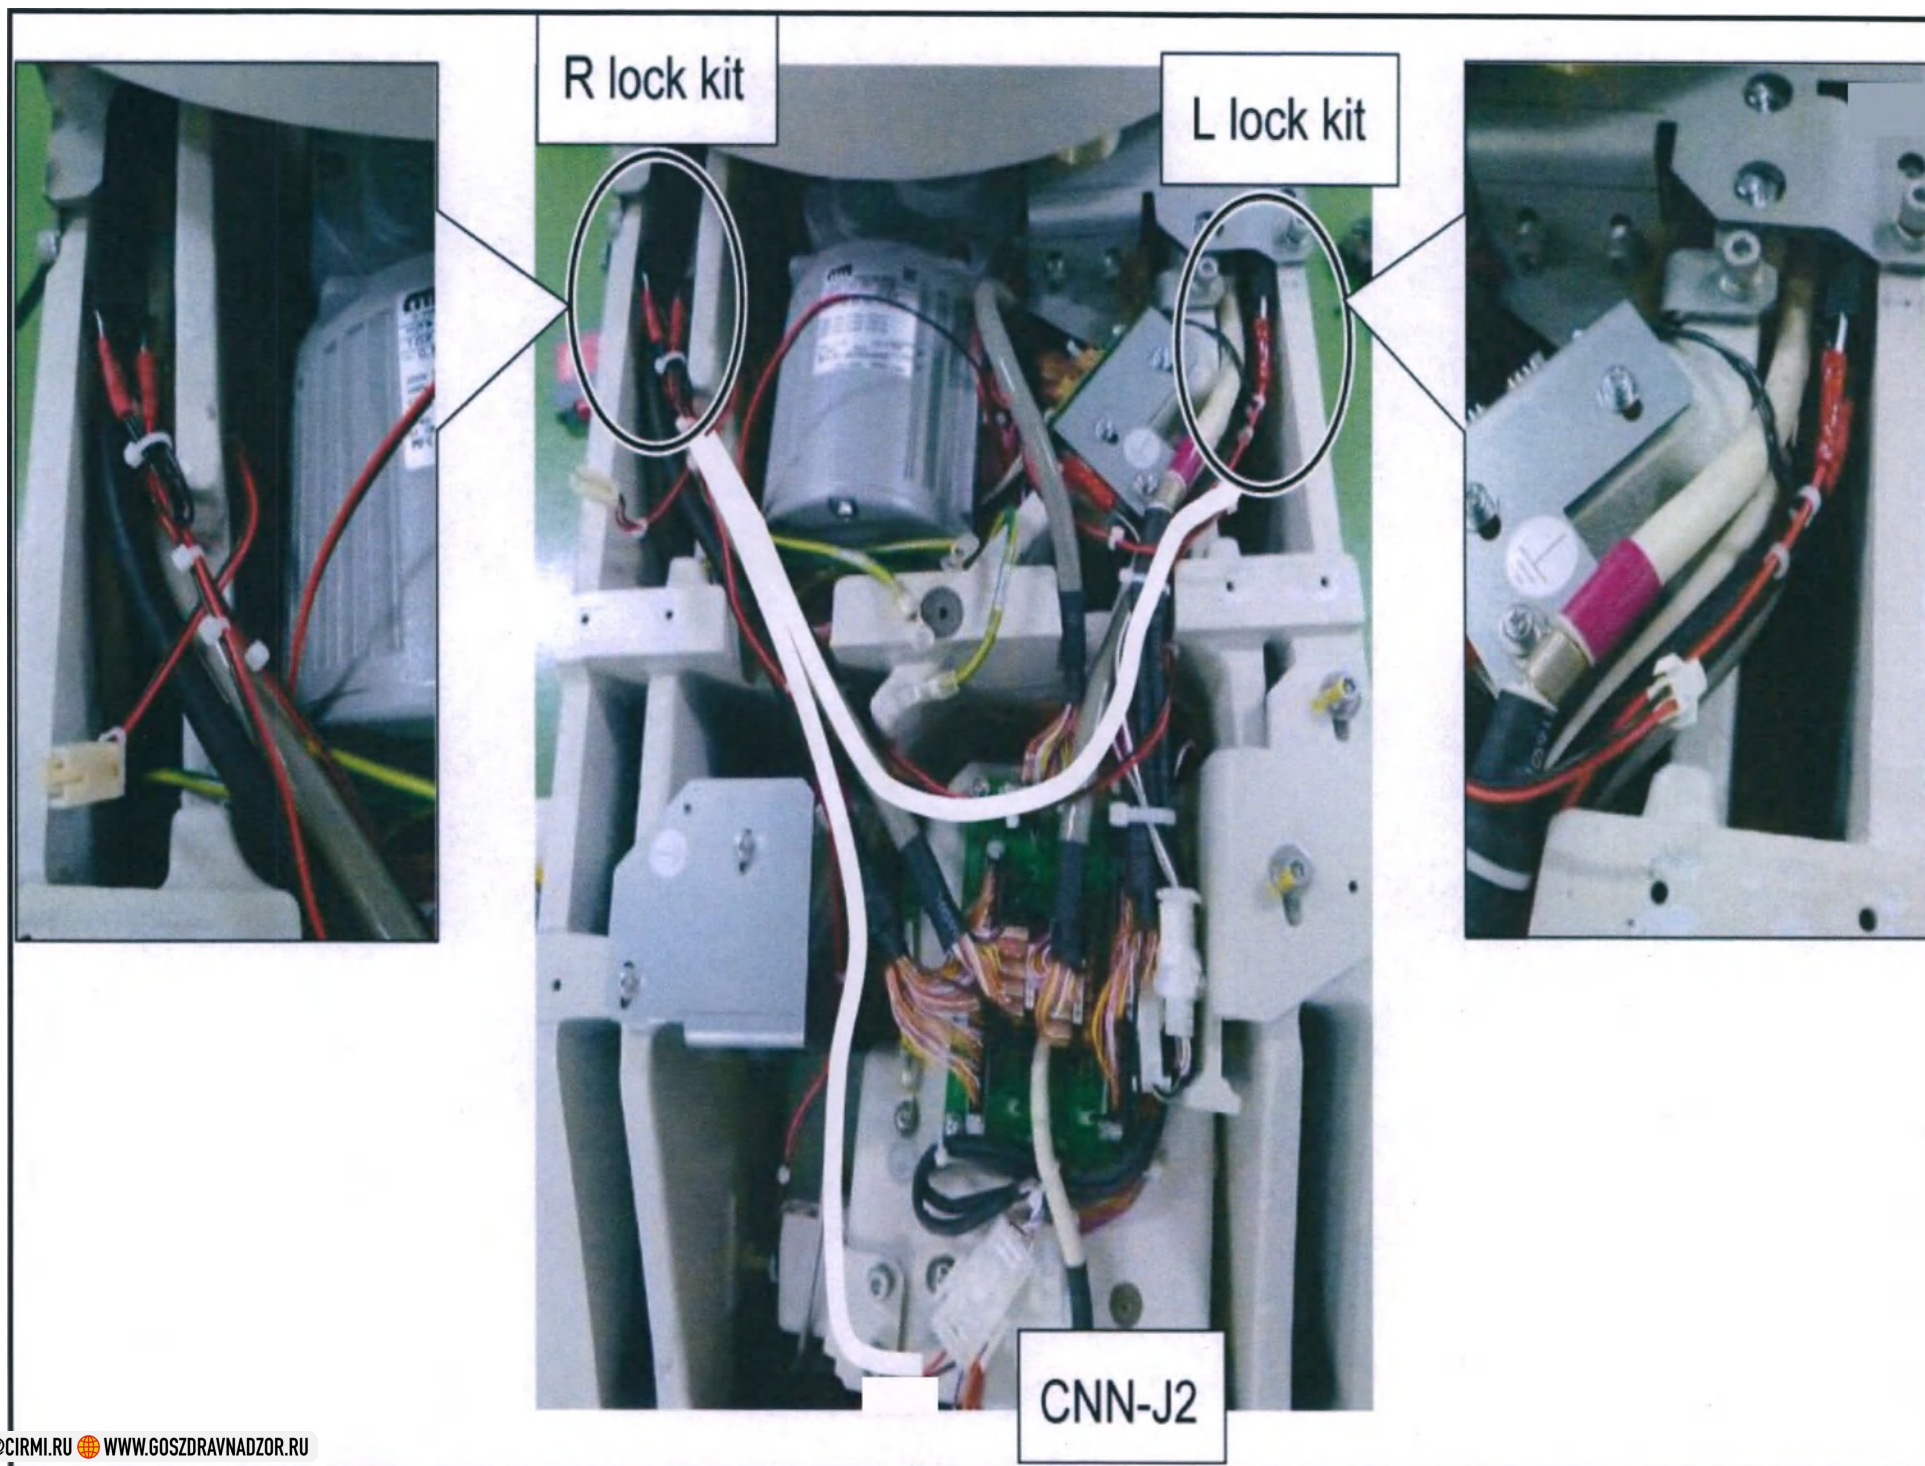



Комплект встроен
внутрь
САТ-850В/В1

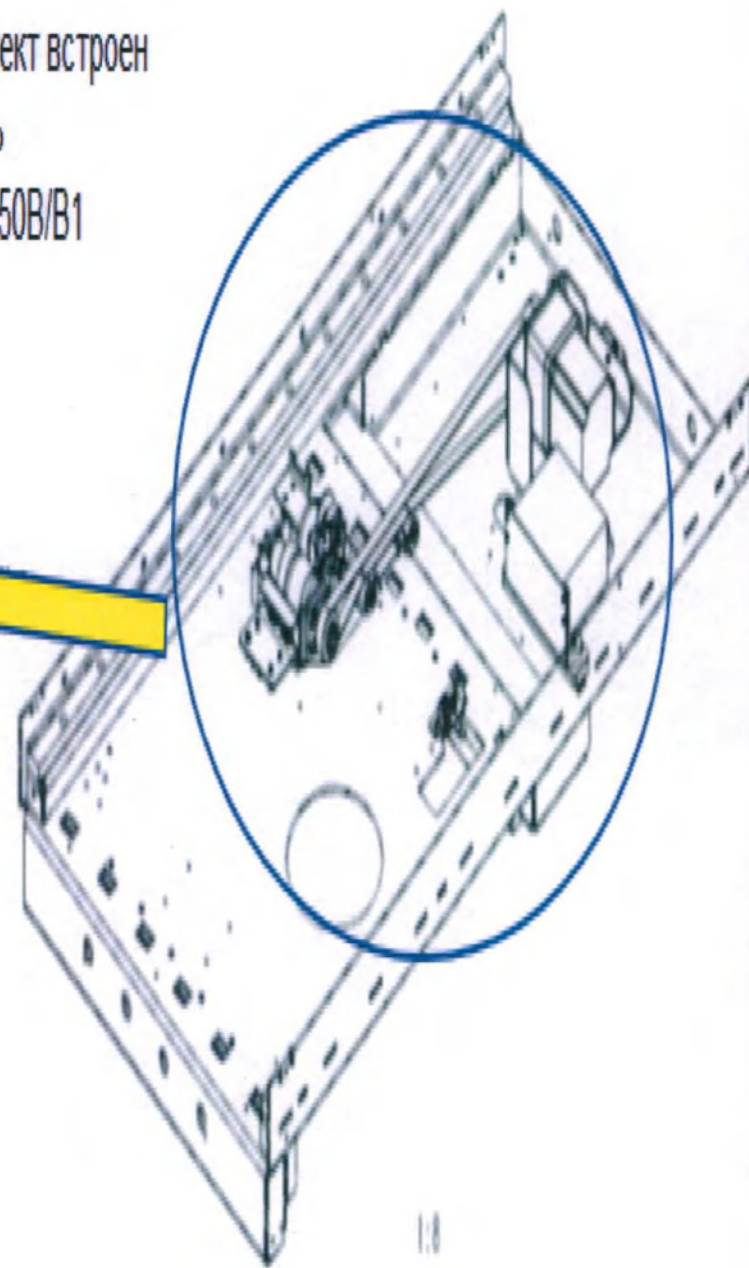

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - программное обеспечение основное - 1 шт.

Study List

Search: Searching default archive for Modality Any Study Date Any Status any

Status	Patient Name	Patient ID	Sex	Modality	# Images	Study Date/Time	Accession #	Study Description
	Embolication Plan	20040408	F	CT	792	08 Apr 2004 09:17		
	40CT SACRAL VERTEBROPLASTY	0404V 808	F	CT	3238	24 Mar 2004 13:05	VISION	
	CHEST CT/PE, SURE IV	0404V TUL	F	CT	2503	07 Feb 2004 17:08	ONE_VISION	
	CHEST CT/PE, SURE IV	0404V TUL	F	CT	2871	05 Feb 2004 22:24	ONE_VISION	
	CHEST CT/PE, SURE IV	0404V TUL	F	CT	3204	05 Feb 2004 15:08	ONE_VISION	
	DSA HEAD 151	3D-INTX...		XA, 18	1627	14 Dec 2013 09:29		INTXNDX
	IO BODY 064	10-INTX...		XA, 18	1542	25 Aug 2013 13:36		INTXNDX
	IO BODY 068	10-INTX...		XA	384	25 Aug 2013 09:58		INTXNDX
	CBA	8902777	M	XA	1624	08 Aug 2013 08:54	2015041700	
	MAPCA			CT	1807	01 May 2015 14:28		CTA
	VNVP, MELCOP	12345		CT	6402	01 May 2015 12:54		Card Core CTA
	Brain CDM Subtraction	MCA Ave...	F	CT, 18	722	01 Apr 2015 20:58	ONE_VISION	CT Angiogram C...
	MRAO PULM	12377		MRA	124	18 Mar 2015 08:11		Card Cardiac Per...
	CEREBRAL ANEURYSM	3D-INTX...		XA	513	11 Jun 2014 14:07	ABC	
	IT ABD RENALS CMRA ONE PATH ROY SPN	1AB-CE...	M	MRA	1138	05 May 2014 20:28		
	10 DSA L-Vert-Aneurysm 301	10 DSA...	F	XA	1625	18 Feb 2014 07:06		
	10 DSA UCA Aneurysm 012	10 DSA...	F	XA	512	27 Jan 2014 08:02		

Filter By

Patient ID: [Search with]

Patient Name: [Search with]

Date of Birth: [Search with]

Accession Number: [Search with]

Study Description: [Search with]

Modality: [Any]

Study Date: [Any]

Search

Applications: Results Study

SA 3D Vessel 3D

Cerebral Aneurysm Analysis

Embolication Plan

CEREBRAL ANEURYSM | 3D-INTX 082 | 11 Jun 2014 14:07

Each: 114 22 Images


Open

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - 1 шт. - персональный компьютер - 1 шт.

143




86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - клавиатура - 1 шт.

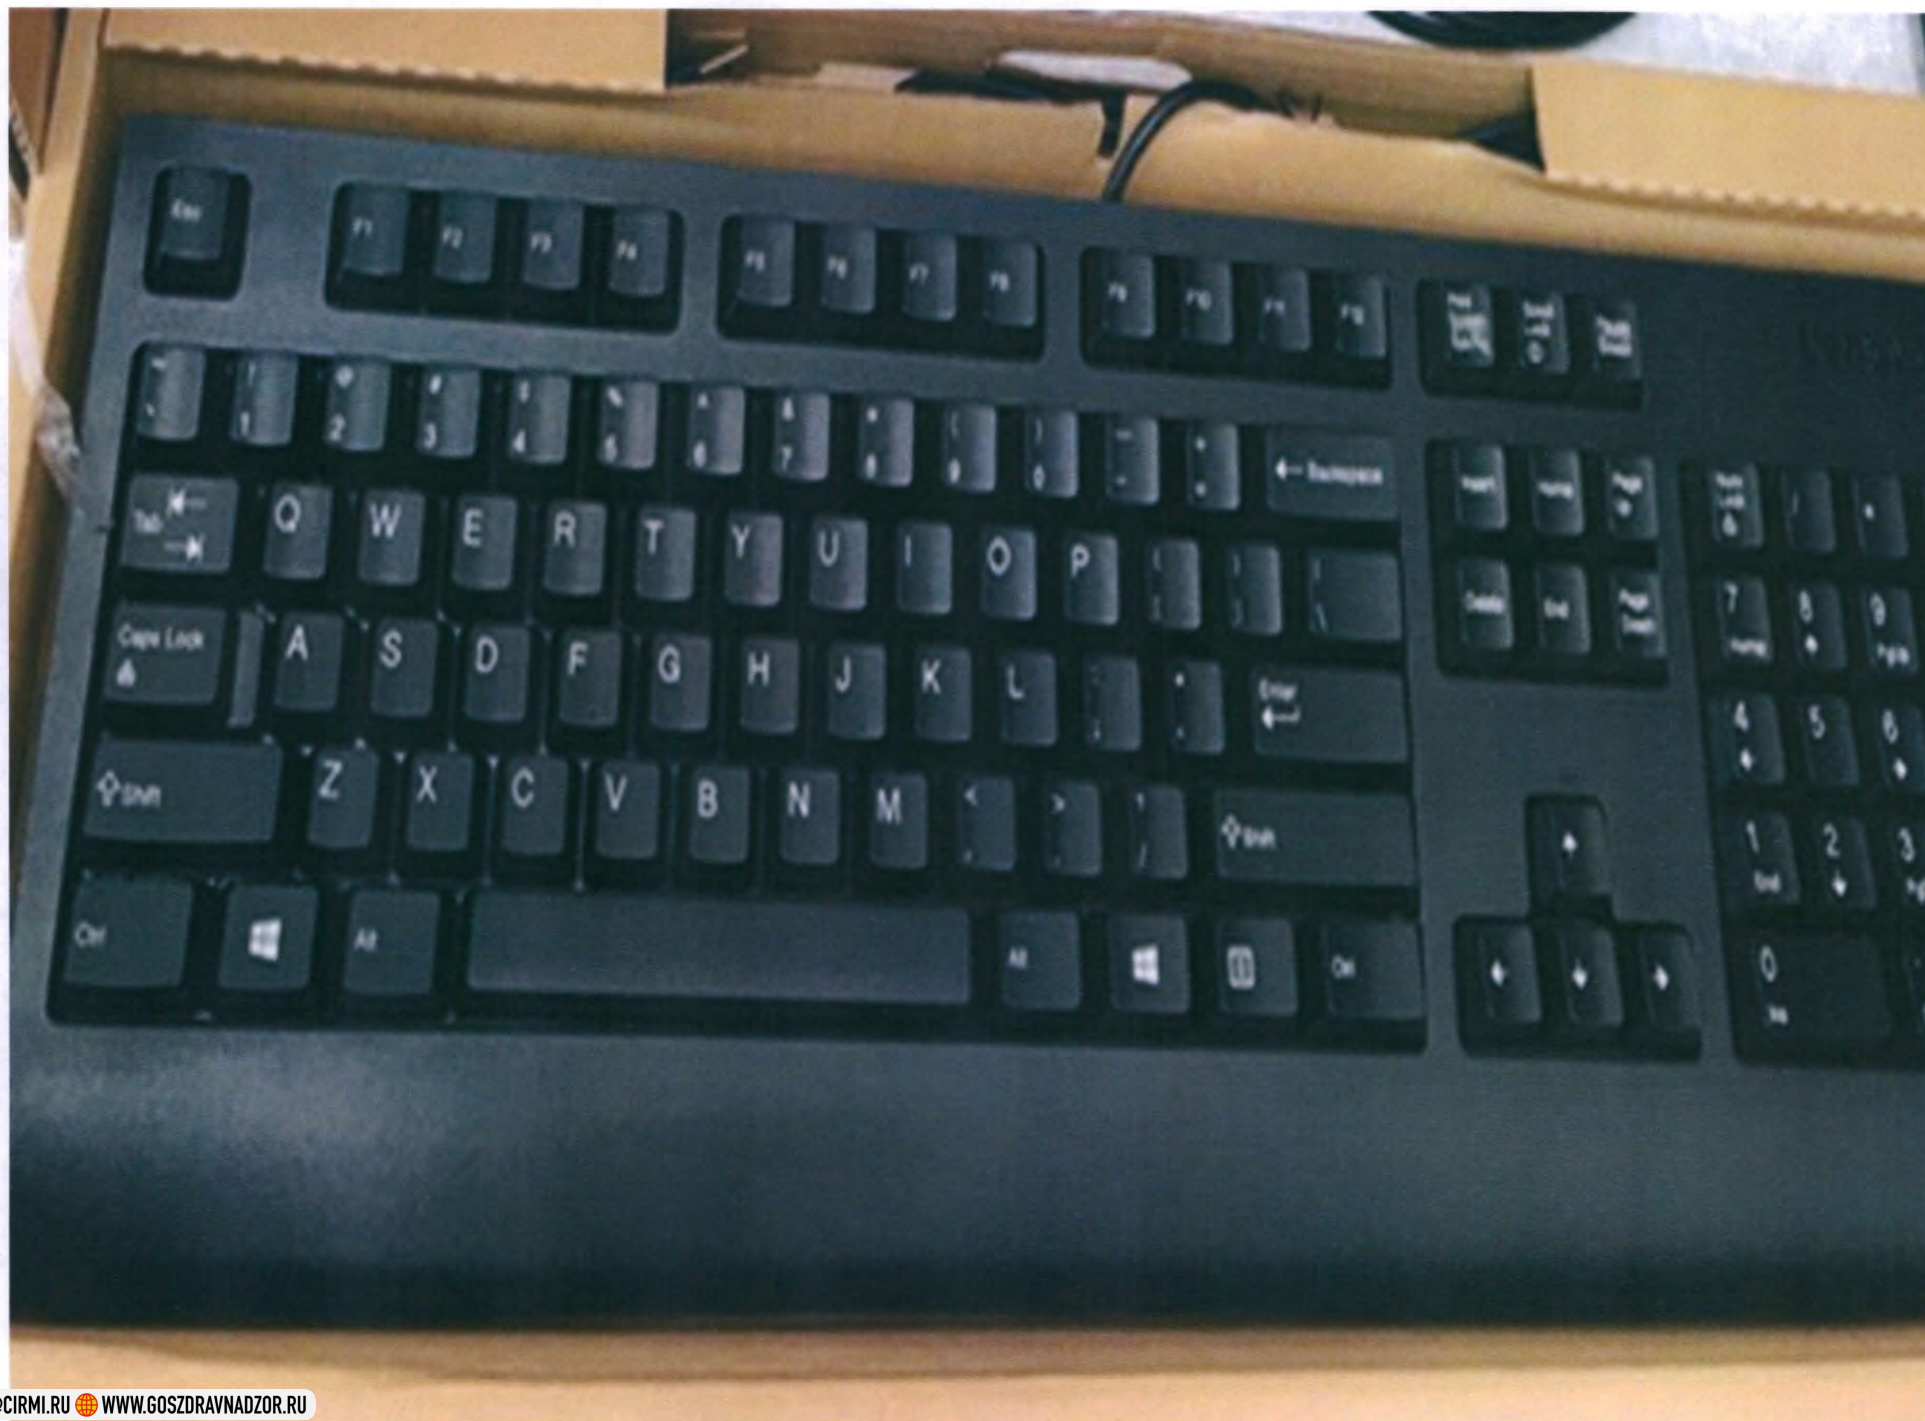

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - клавиатура - 1 шт. - манипулятор «мышь» - 1 шт.

142

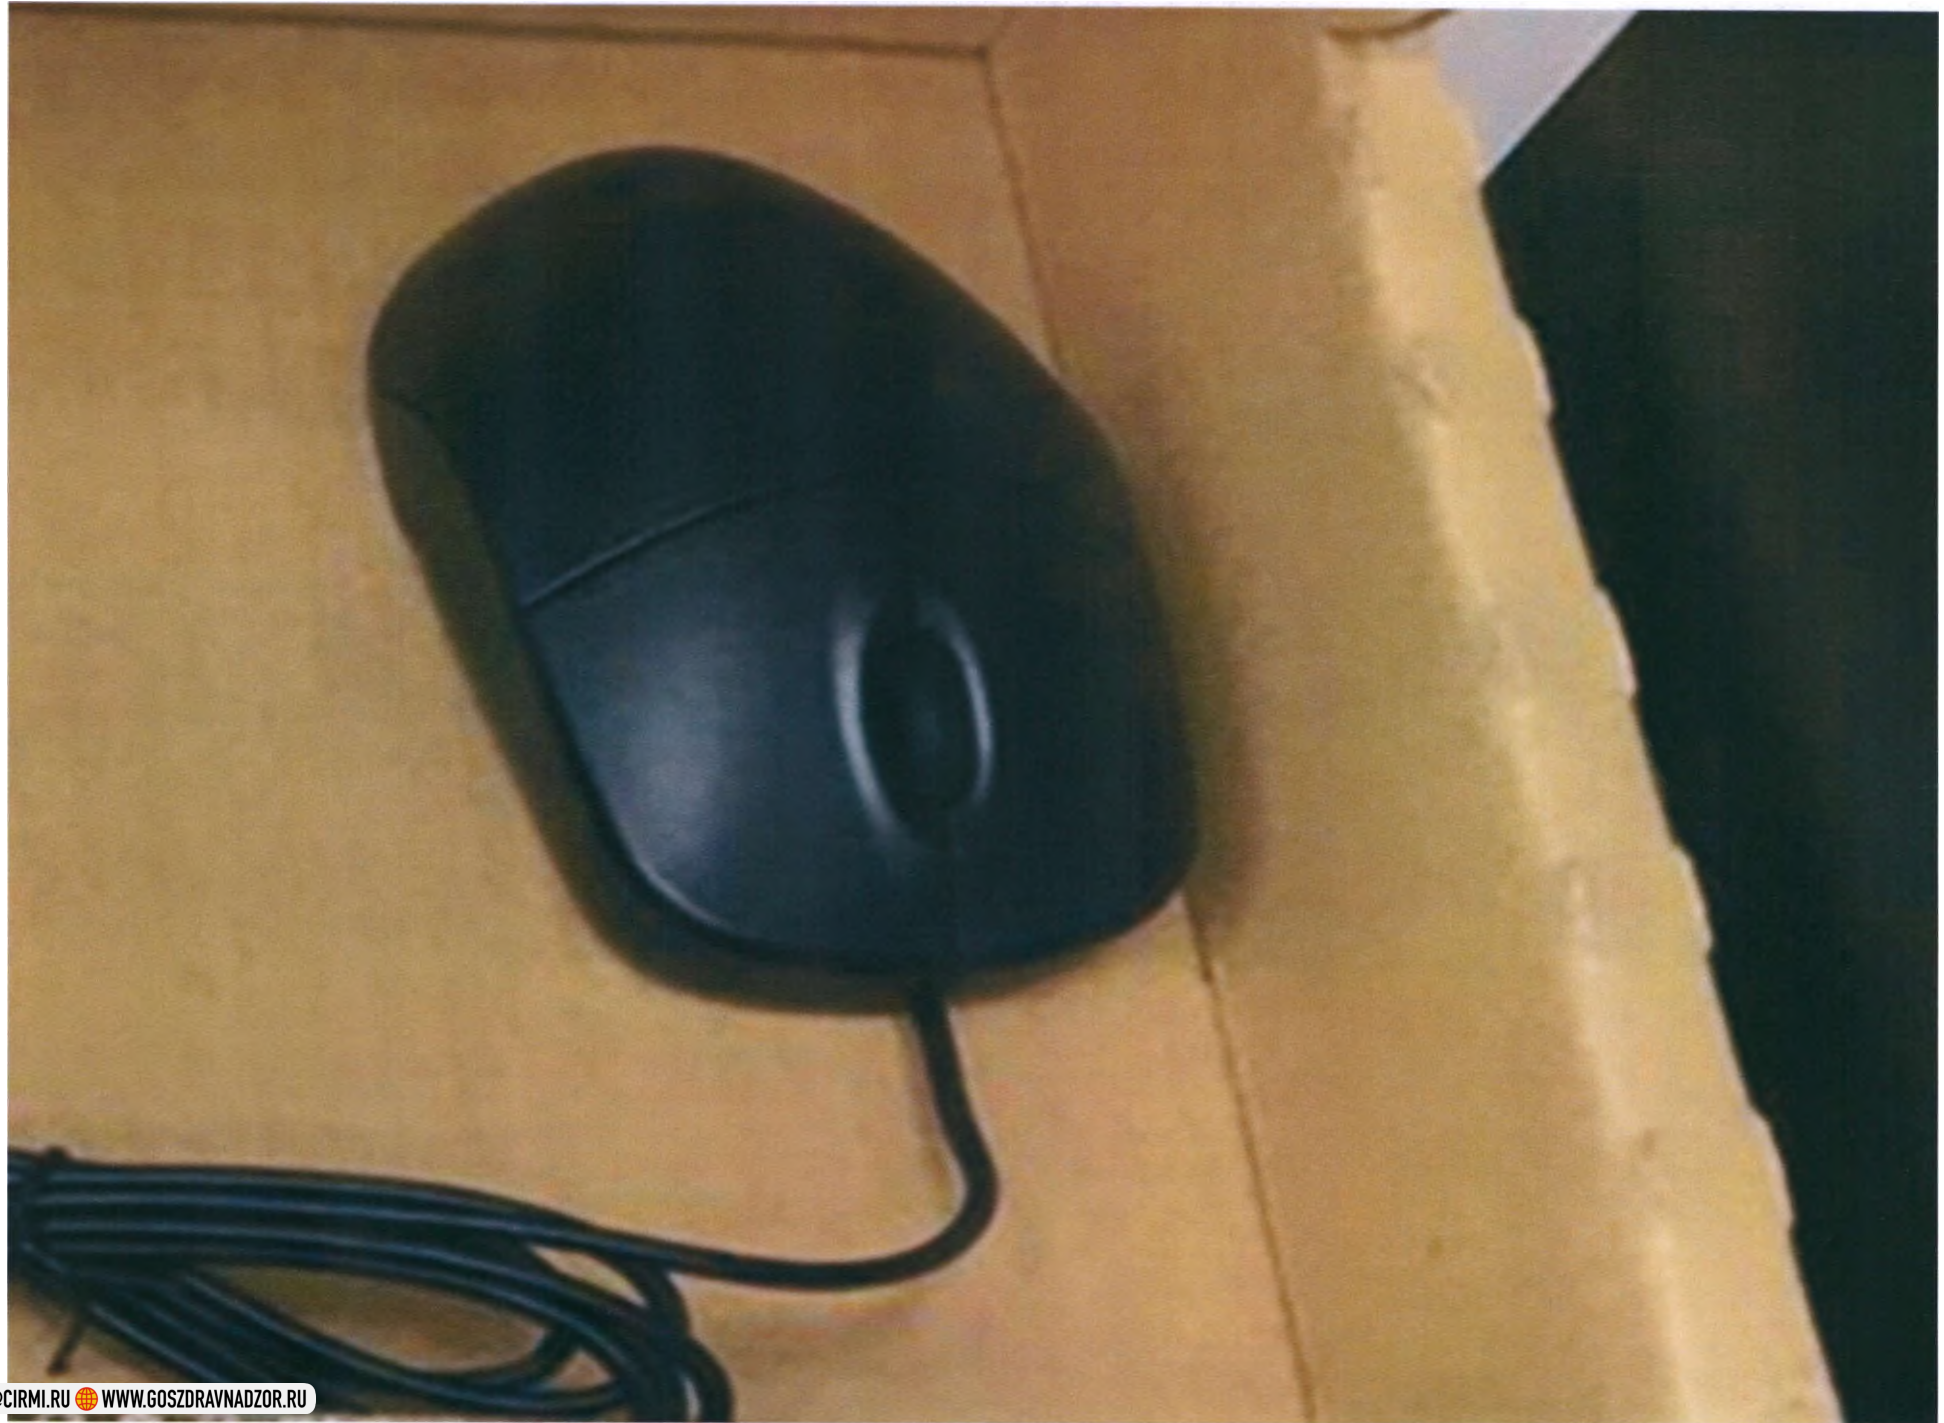


86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - концентратор - 1 шт.



86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - комплект кабелей - 4 шт.



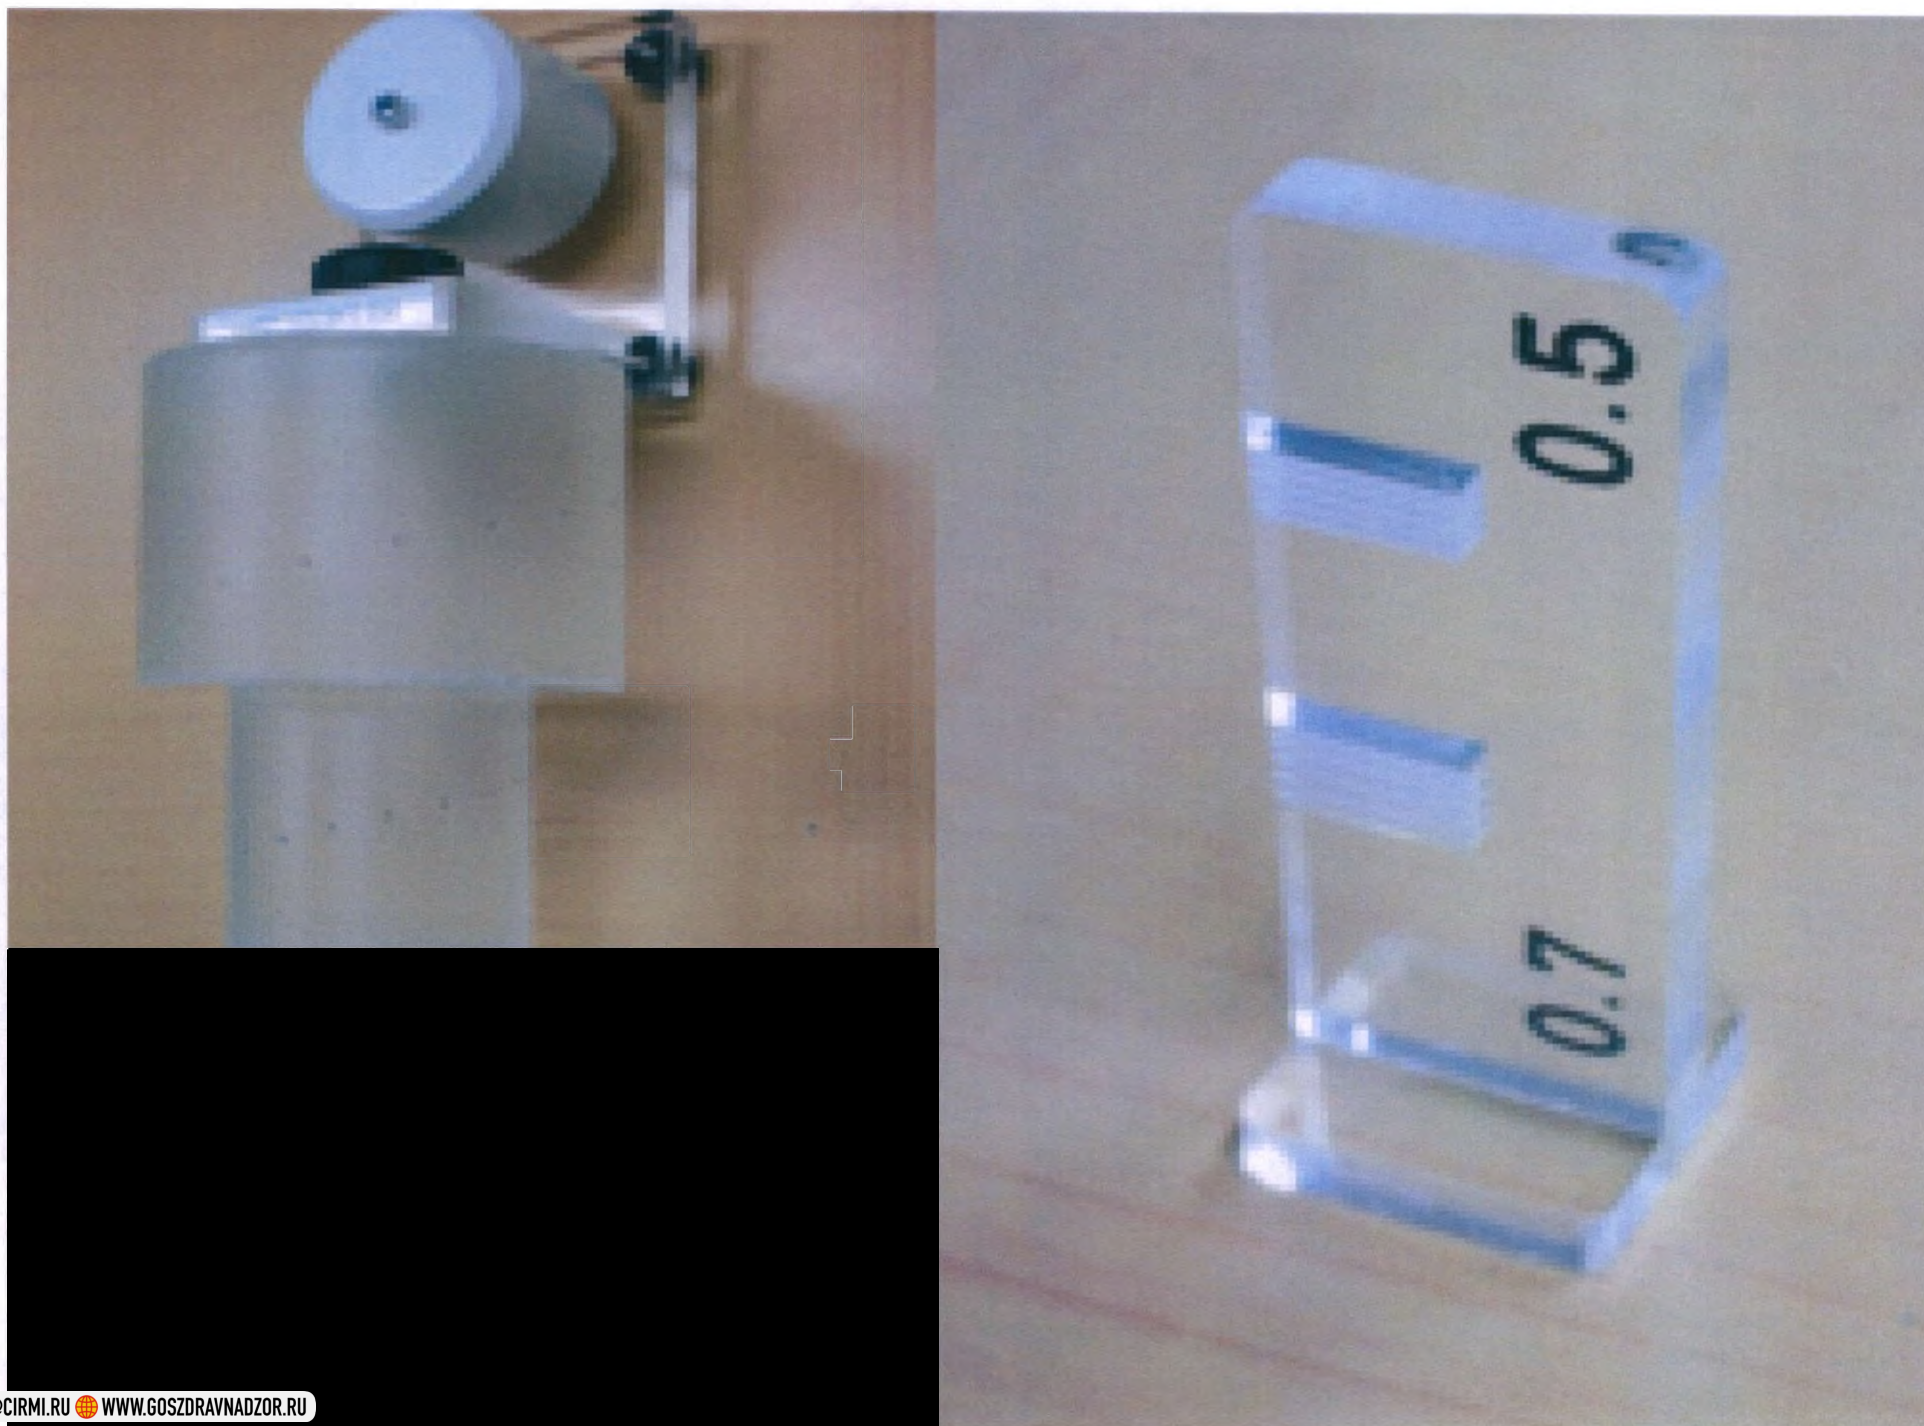

87. Монитор для Ангиографической рабочей станции - не более 4 шт.


148



88. Комплект дополнительного монитора для Ангиографической рабочей станции.



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет интерфейса для клиентского анализа;

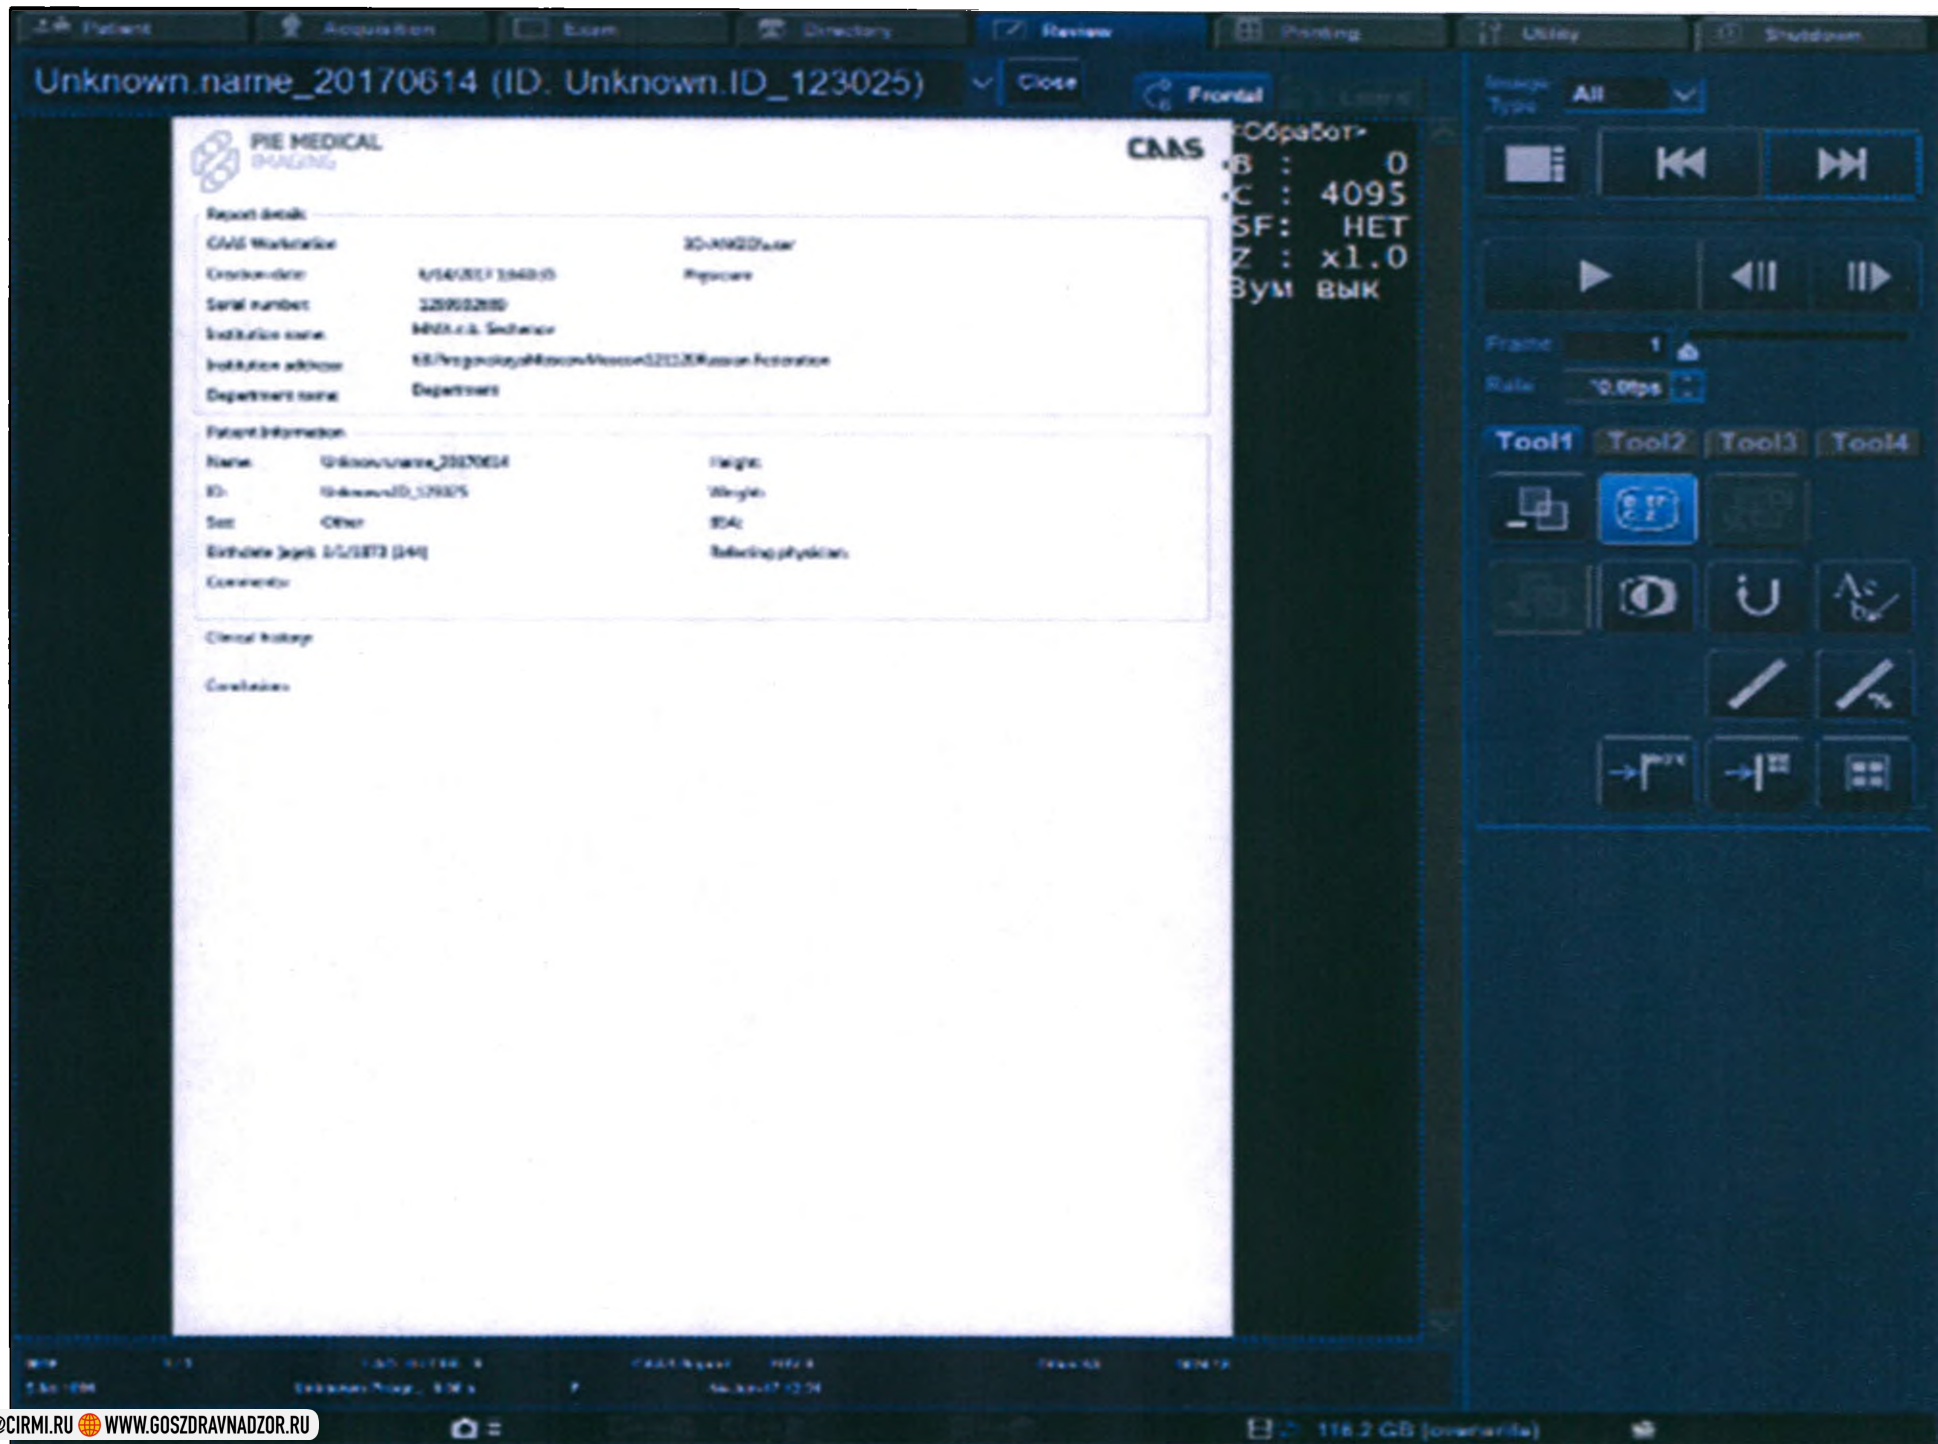

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QCA (анализ коронарных артерий);

CAAS Workstation 7.1.1 - 3Dadmin

Hide image ribbon

View

Hide report overview

Report

3Dviewer Page

Viewing

QCA 1

Patient

QCA

Stent

LVA

RVA

Report

Save Report

DRONKOVA RAZSA MIHAILOVNA - 15.06.2017

CAAS

DRONKOVA RAZSA MIHAILOVNA
20.03.1948
Female
XAJ0170625134022

PIE MEDICAL IMAGING

CAAS

Report details

CAAS Workstation	3D-ANGIO3Dadmin
Creation date:	15.06.2017 17:11:40
Serial number:	1209932669
Institution name:	MIHA n.b. Sechenov
Institution address:	68 Pirogovskaya Moscow Moscow 121120 Russian Federation
Department name:	Department

Patient Information

Name:	DRONKOVA RAZSA MIHAILOVNA	Height:	167 cm
ID:	37 478/2017	Weight:	110 kg
Sex:	Female	BSA:	2.16 m ²
Birthdate (age):	20.03.1948 (69)	Referring physician:	

Comments:

Clinical history:

Conclusion:

CAAS Workstation 7.1.1

1 / 2

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QVA (анализ сосудов);



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа LVA (анализ левого желудочка);

CAAS Workstation 7.1.1 - 30admin

CAAS

Report
☒ Header Page
☐ Viewing
☐ QCA 1

Hide image ribbon

Hide report overview

View

Patient

QCA

Stent

LVA

RVA

Report

Save Report

DRDENKOVA RAISA MIKHAILOVNA - 15.06.2017

DRDENKOVA RAISA MIKHAILOVNA
 20.01.1948
 Female
 XA70170611114022

PIE MEDICAL IMAGING

Report details

CAAS Workstation	3D-ANGIOadmin
Creation date	15.06.2017 17:11:40
Serial number	1299932669
Institution name	MMA n.b. Sechenov
Institution address	68.PirogovskayaMoscowMoscow121120Russian Federation
Department name	Department

Patient Information

Name	DRDENKOVA RAISA MIKHAILOVNA	Height	167 cm
ID	37 478/2017	Weight	110 kg
Sex	Female	BSA	2.16 m ²
Birthdate (age)	20.01.1948 (69)	Referring physician	

Comments


Clinical history

Conclusion


CAAS Workstation 7.1.1

1 / 2


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа RVA (анализ правого желудочка);

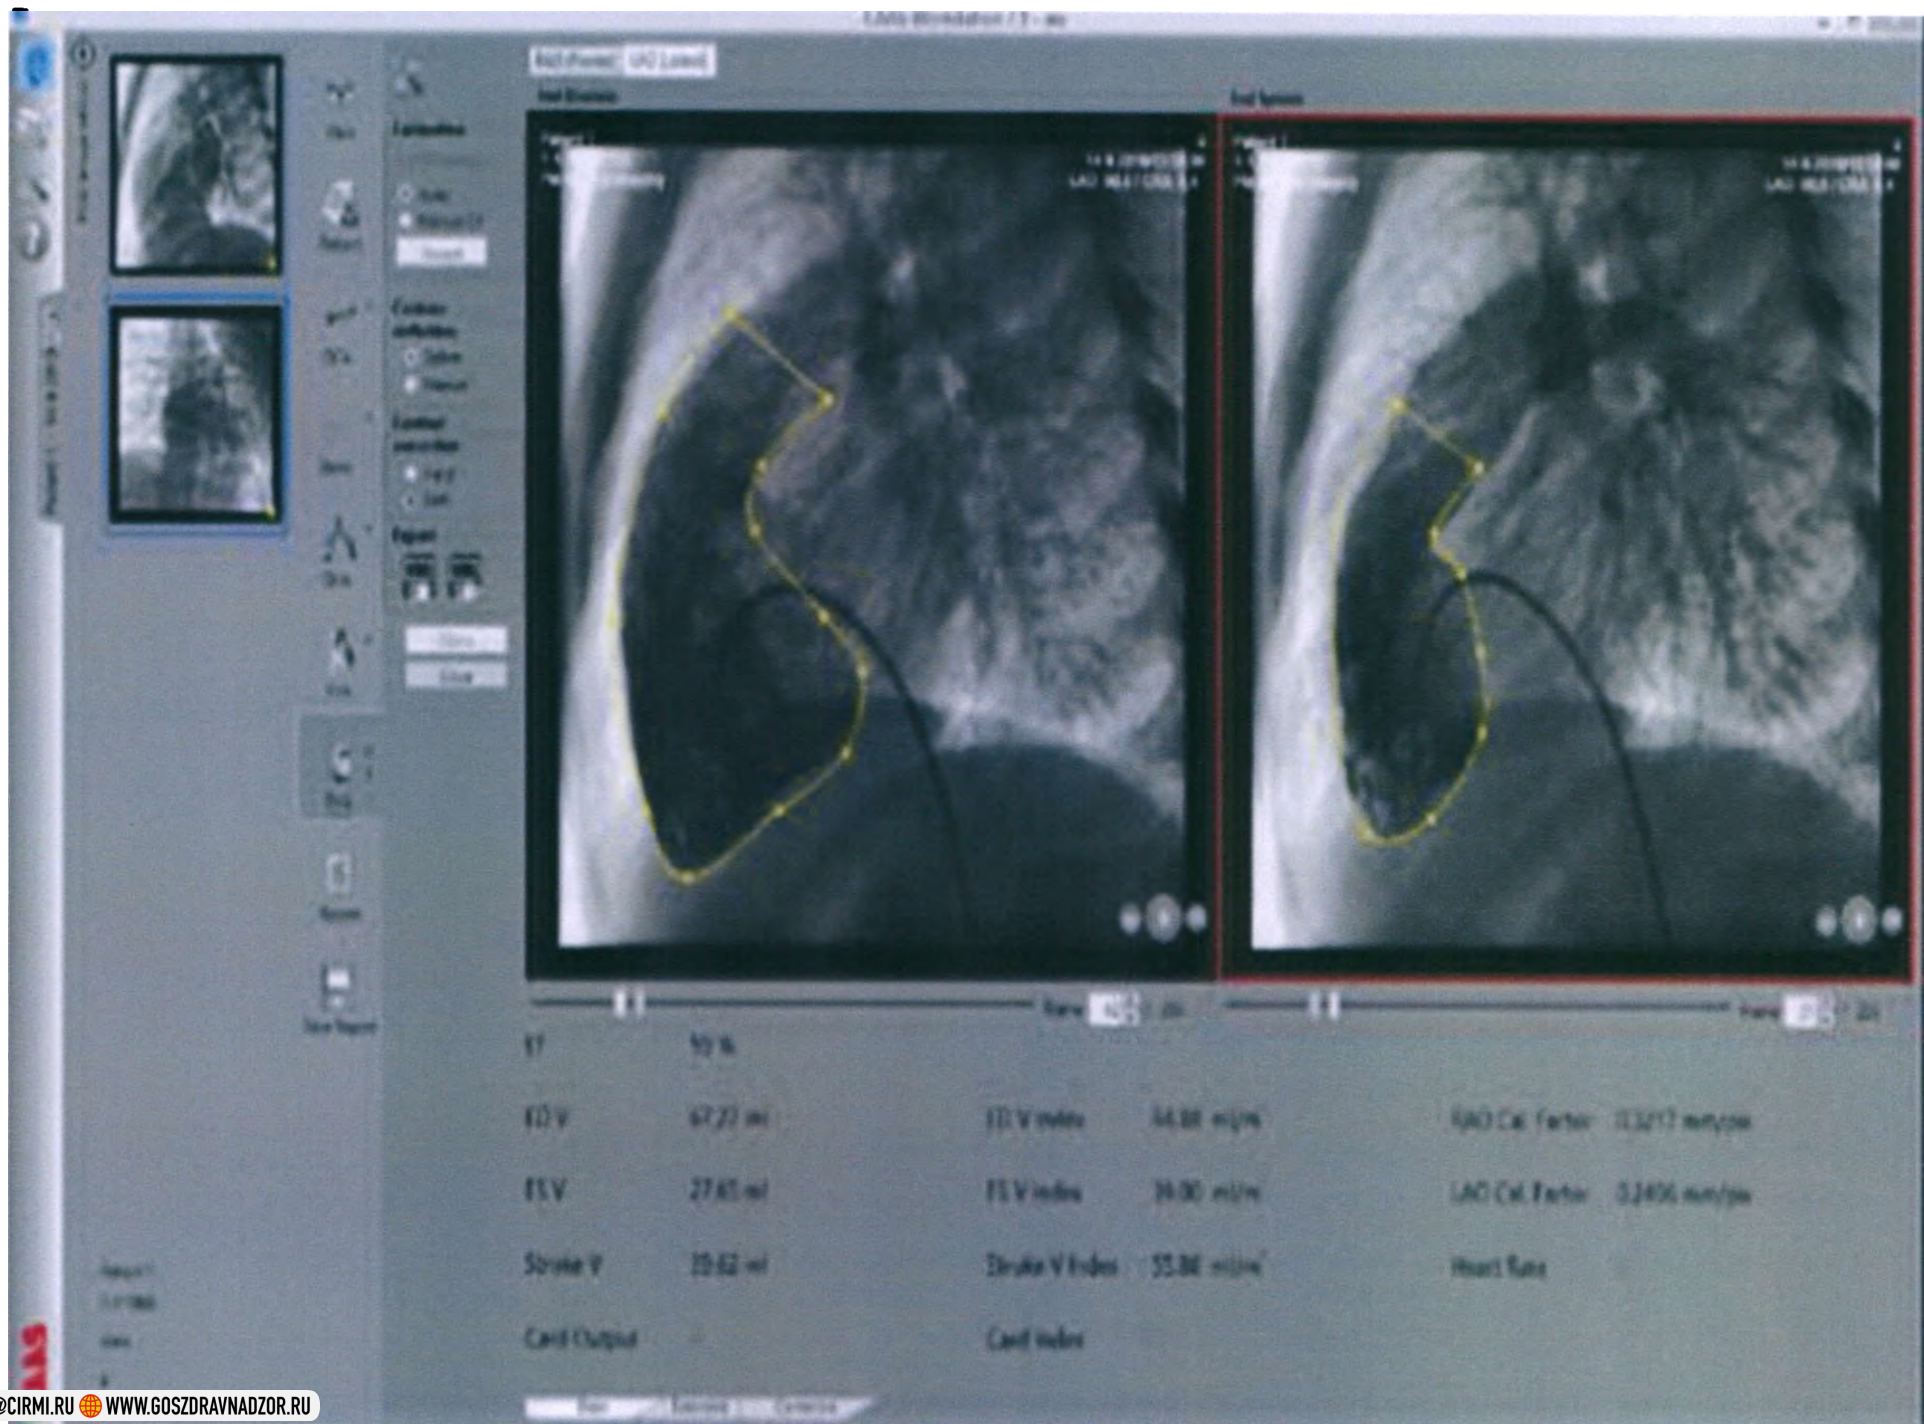


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QCA3D (3D-анализ коронарных артерий);

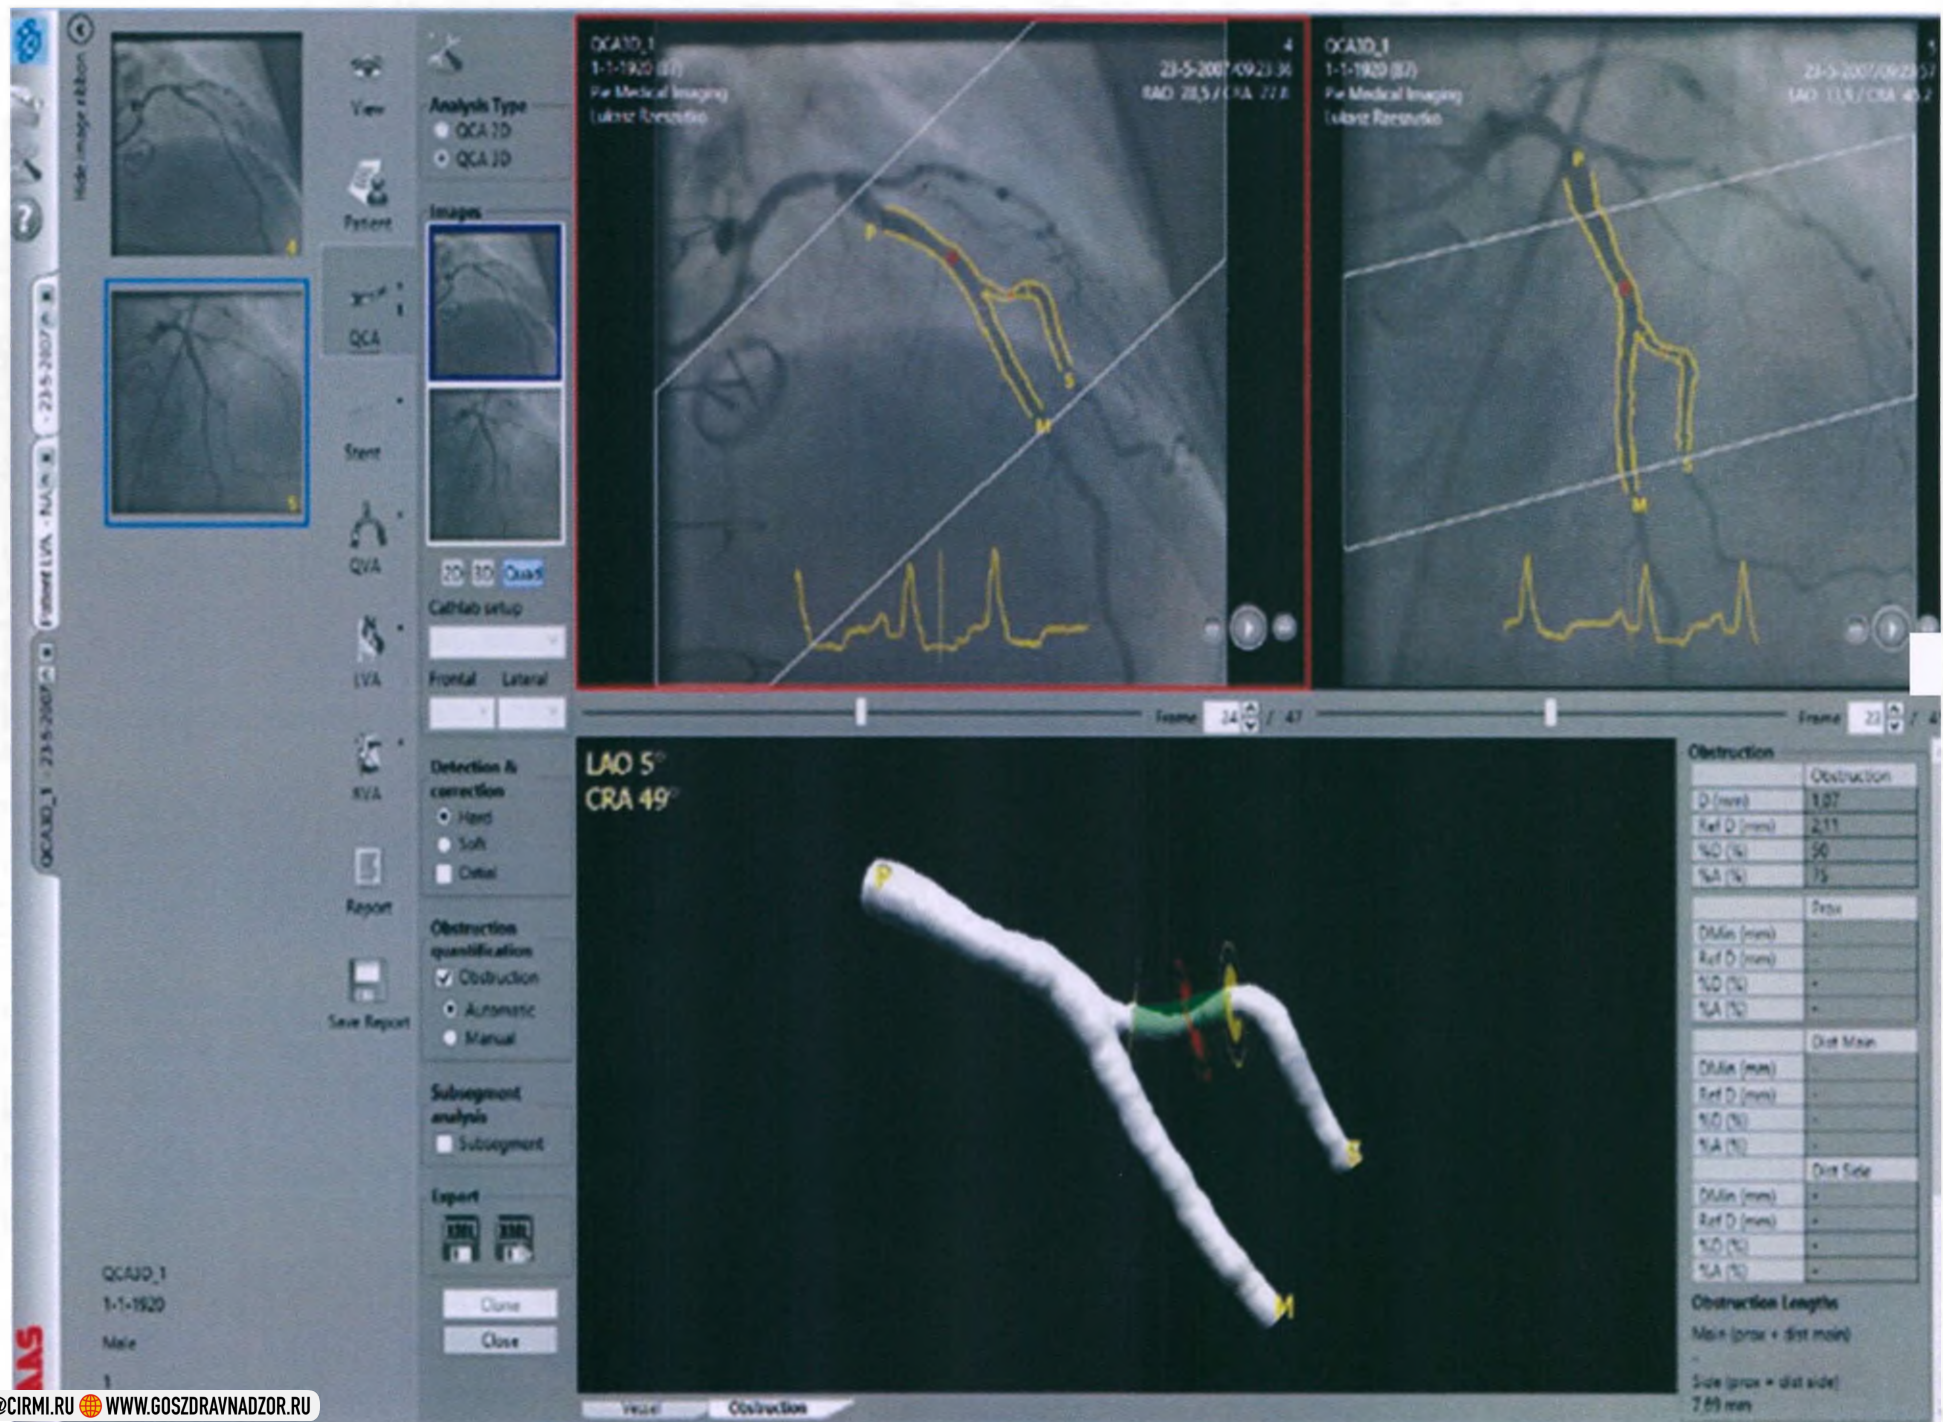


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа Stent Enhancer (отображение с контрастированием стента);

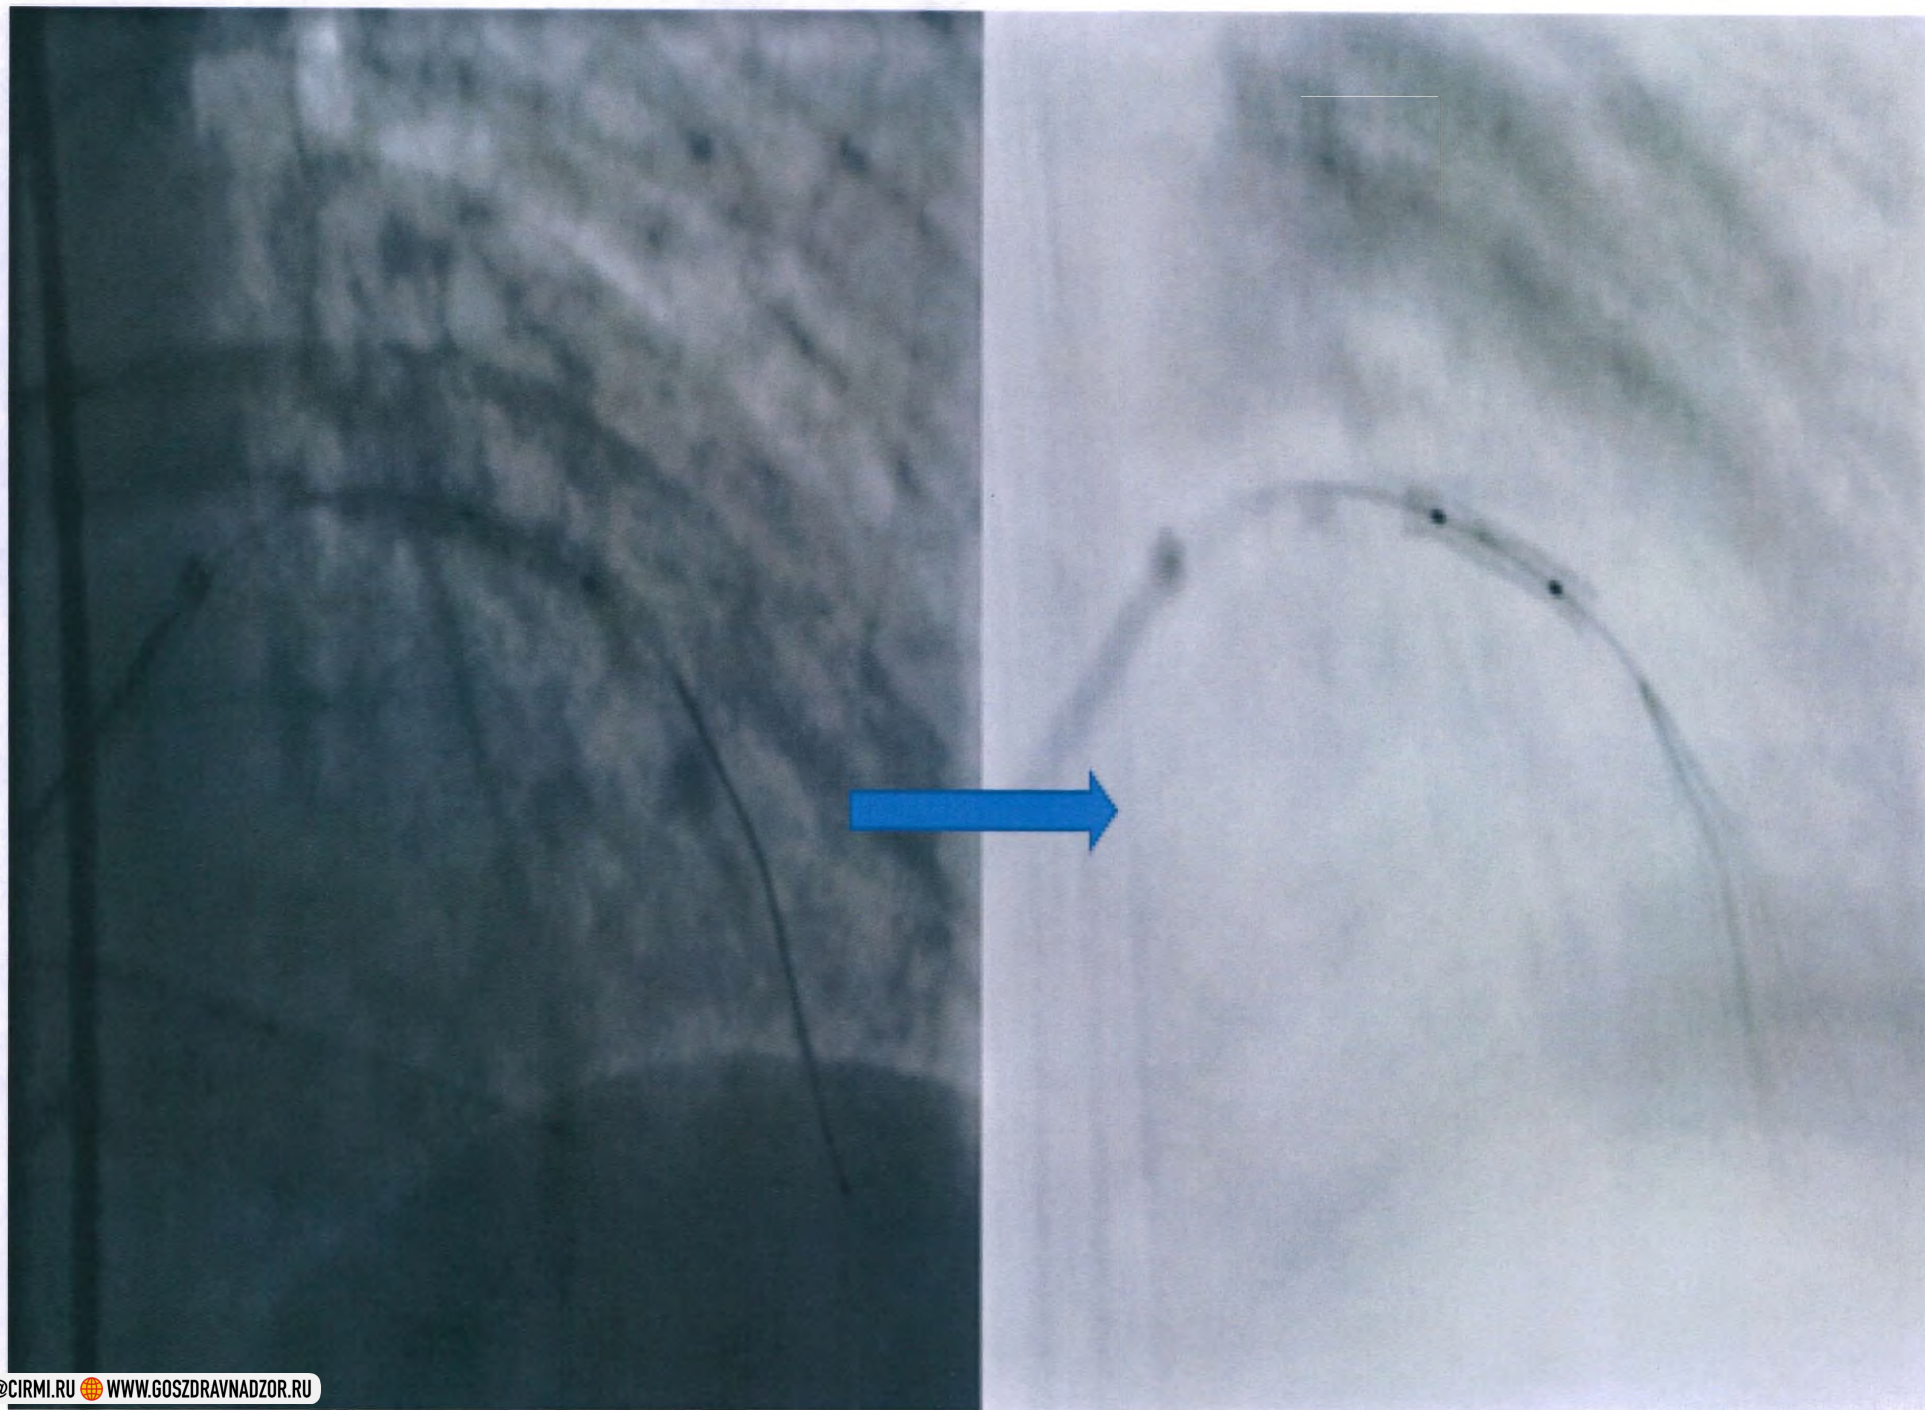

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа IV-LINQ (одновременная регистрация рентгеновских изображений и изображений ВСУЗИ/ОКТ);

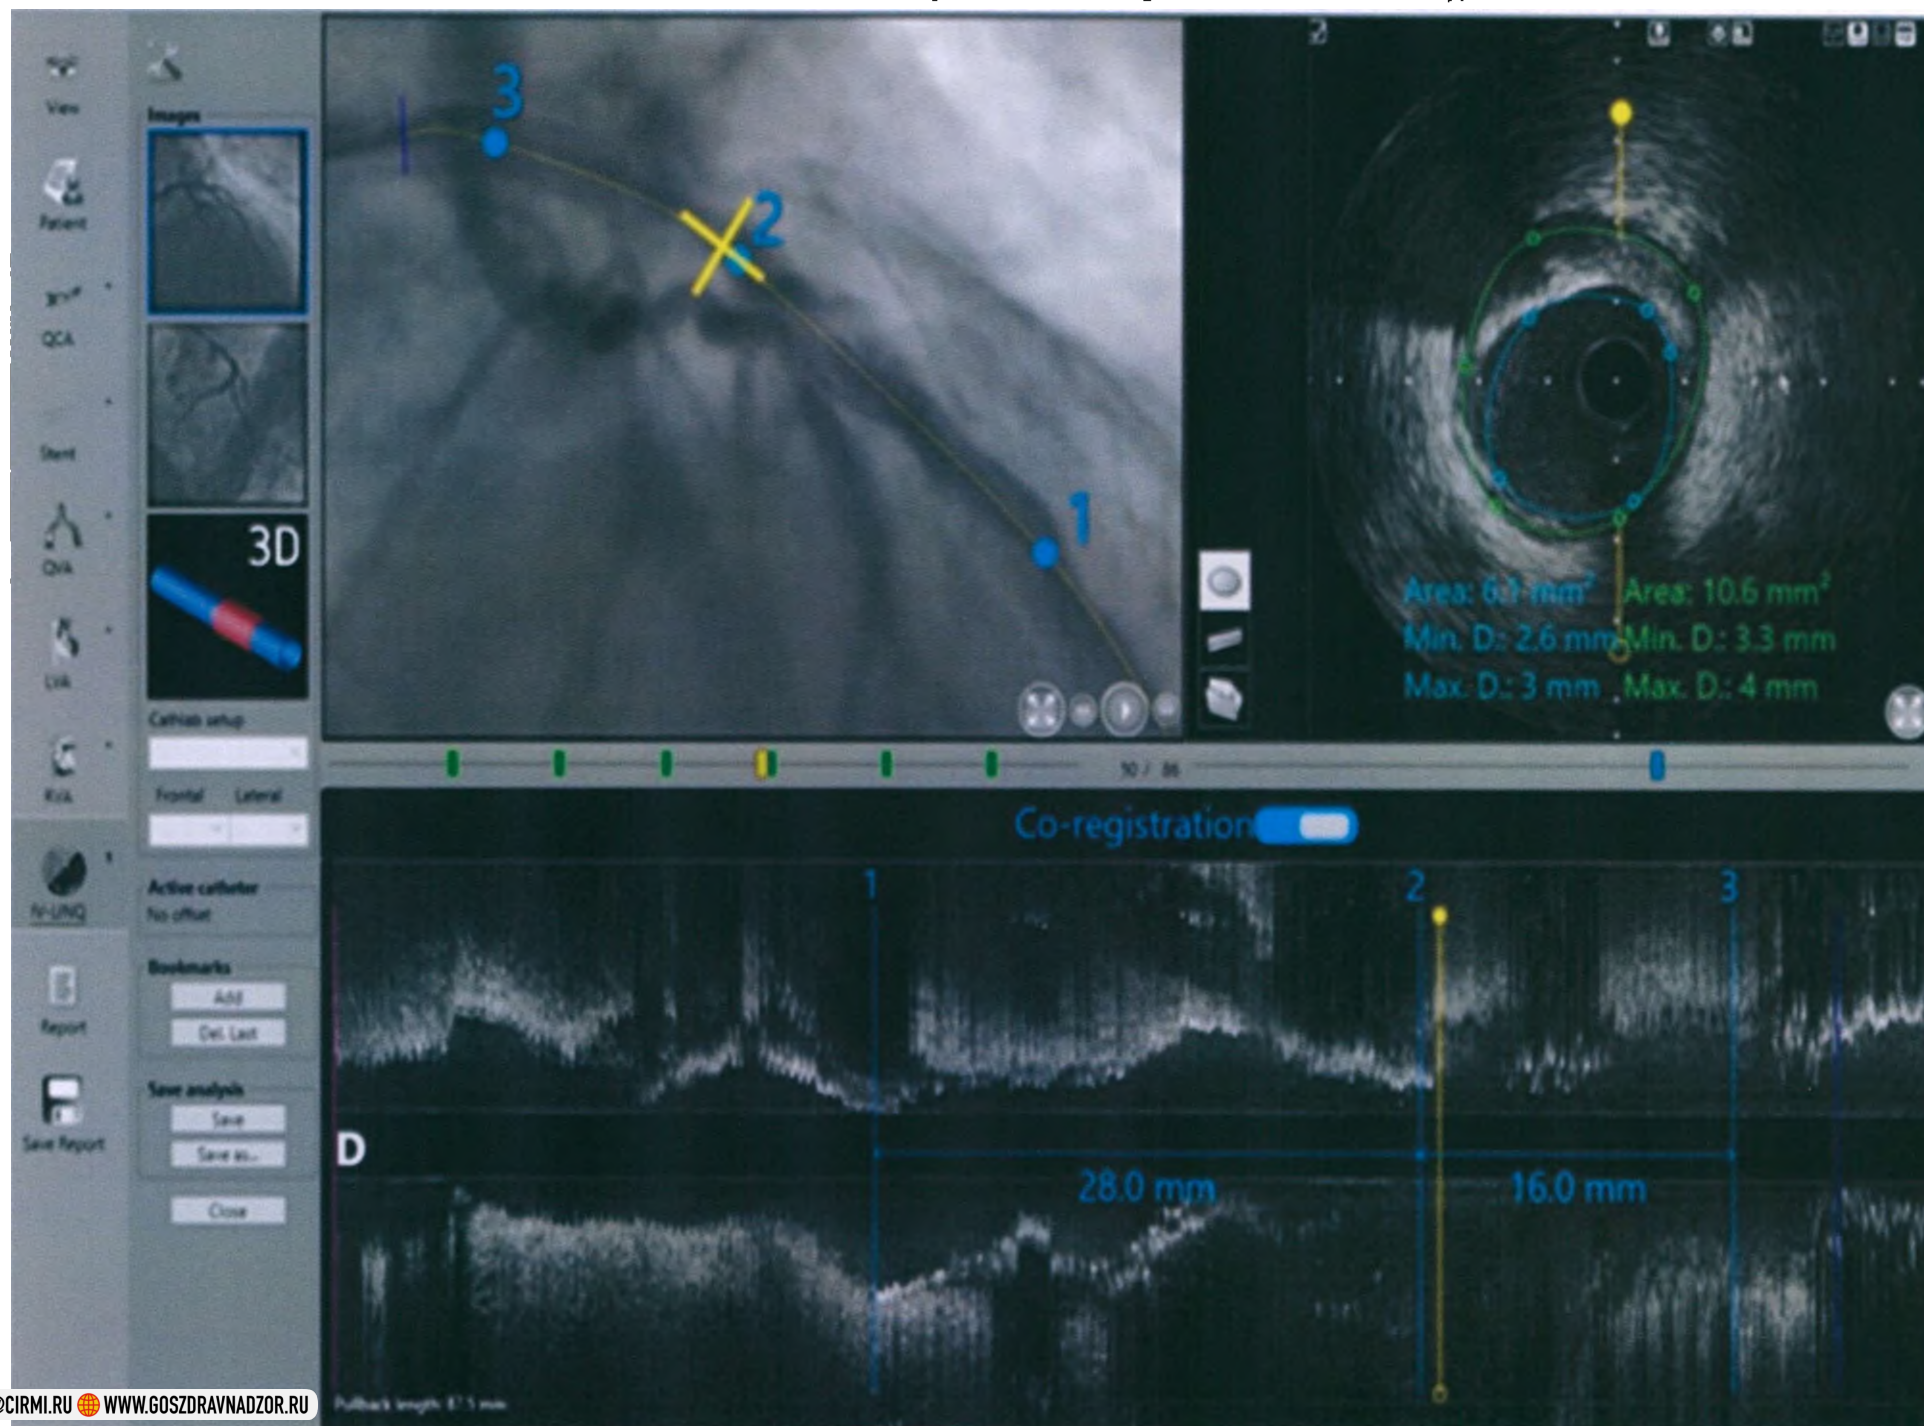


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для 3D-картирования;

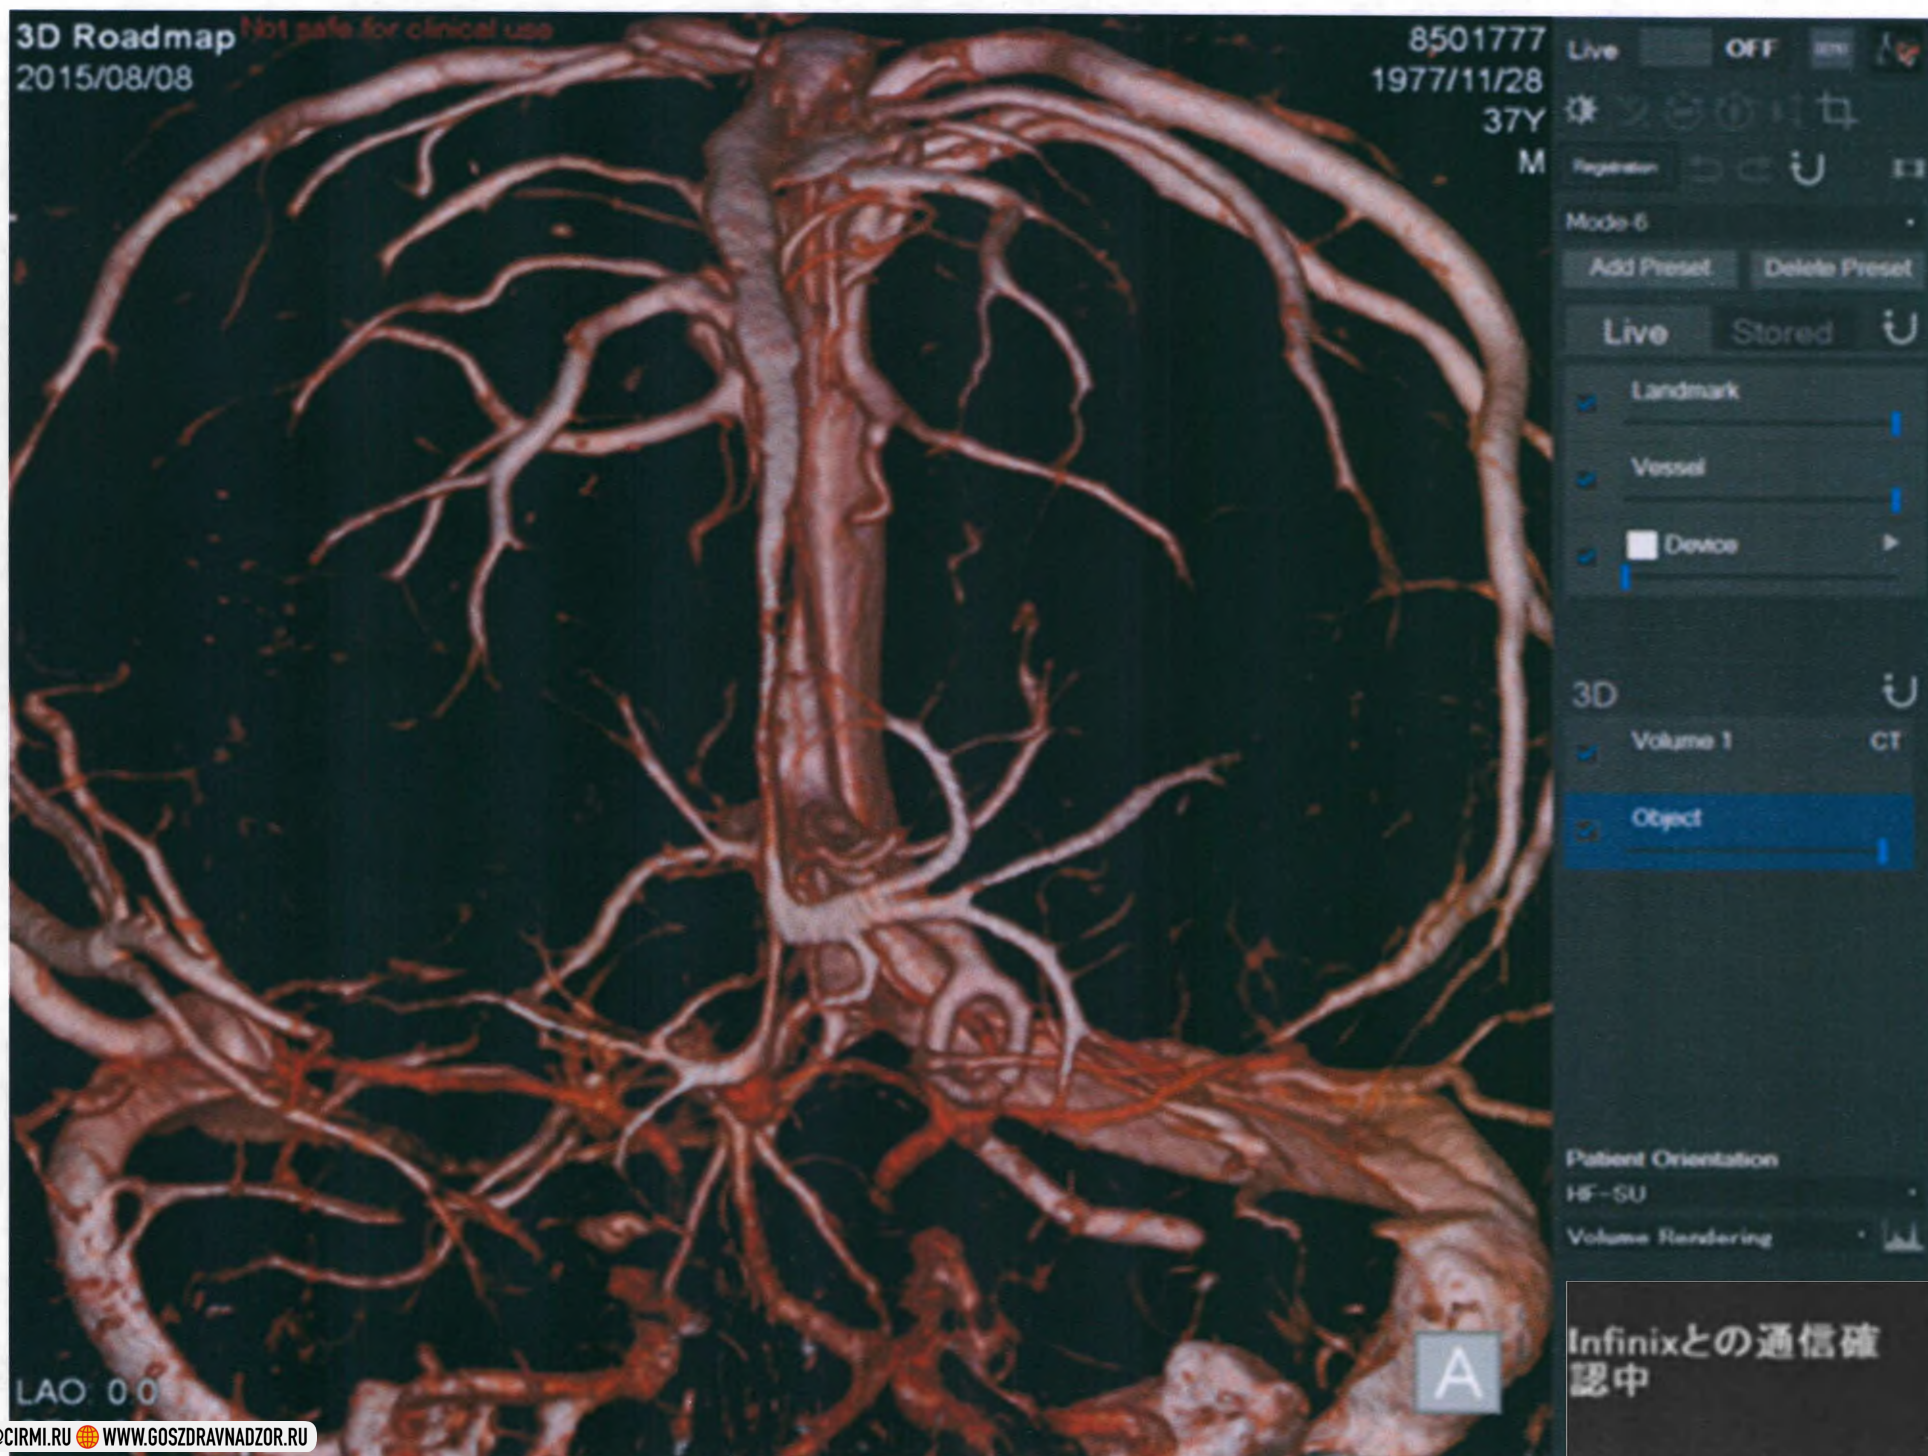


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для мультимодального картирования;




89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для поддержки TAVR (3mensio);

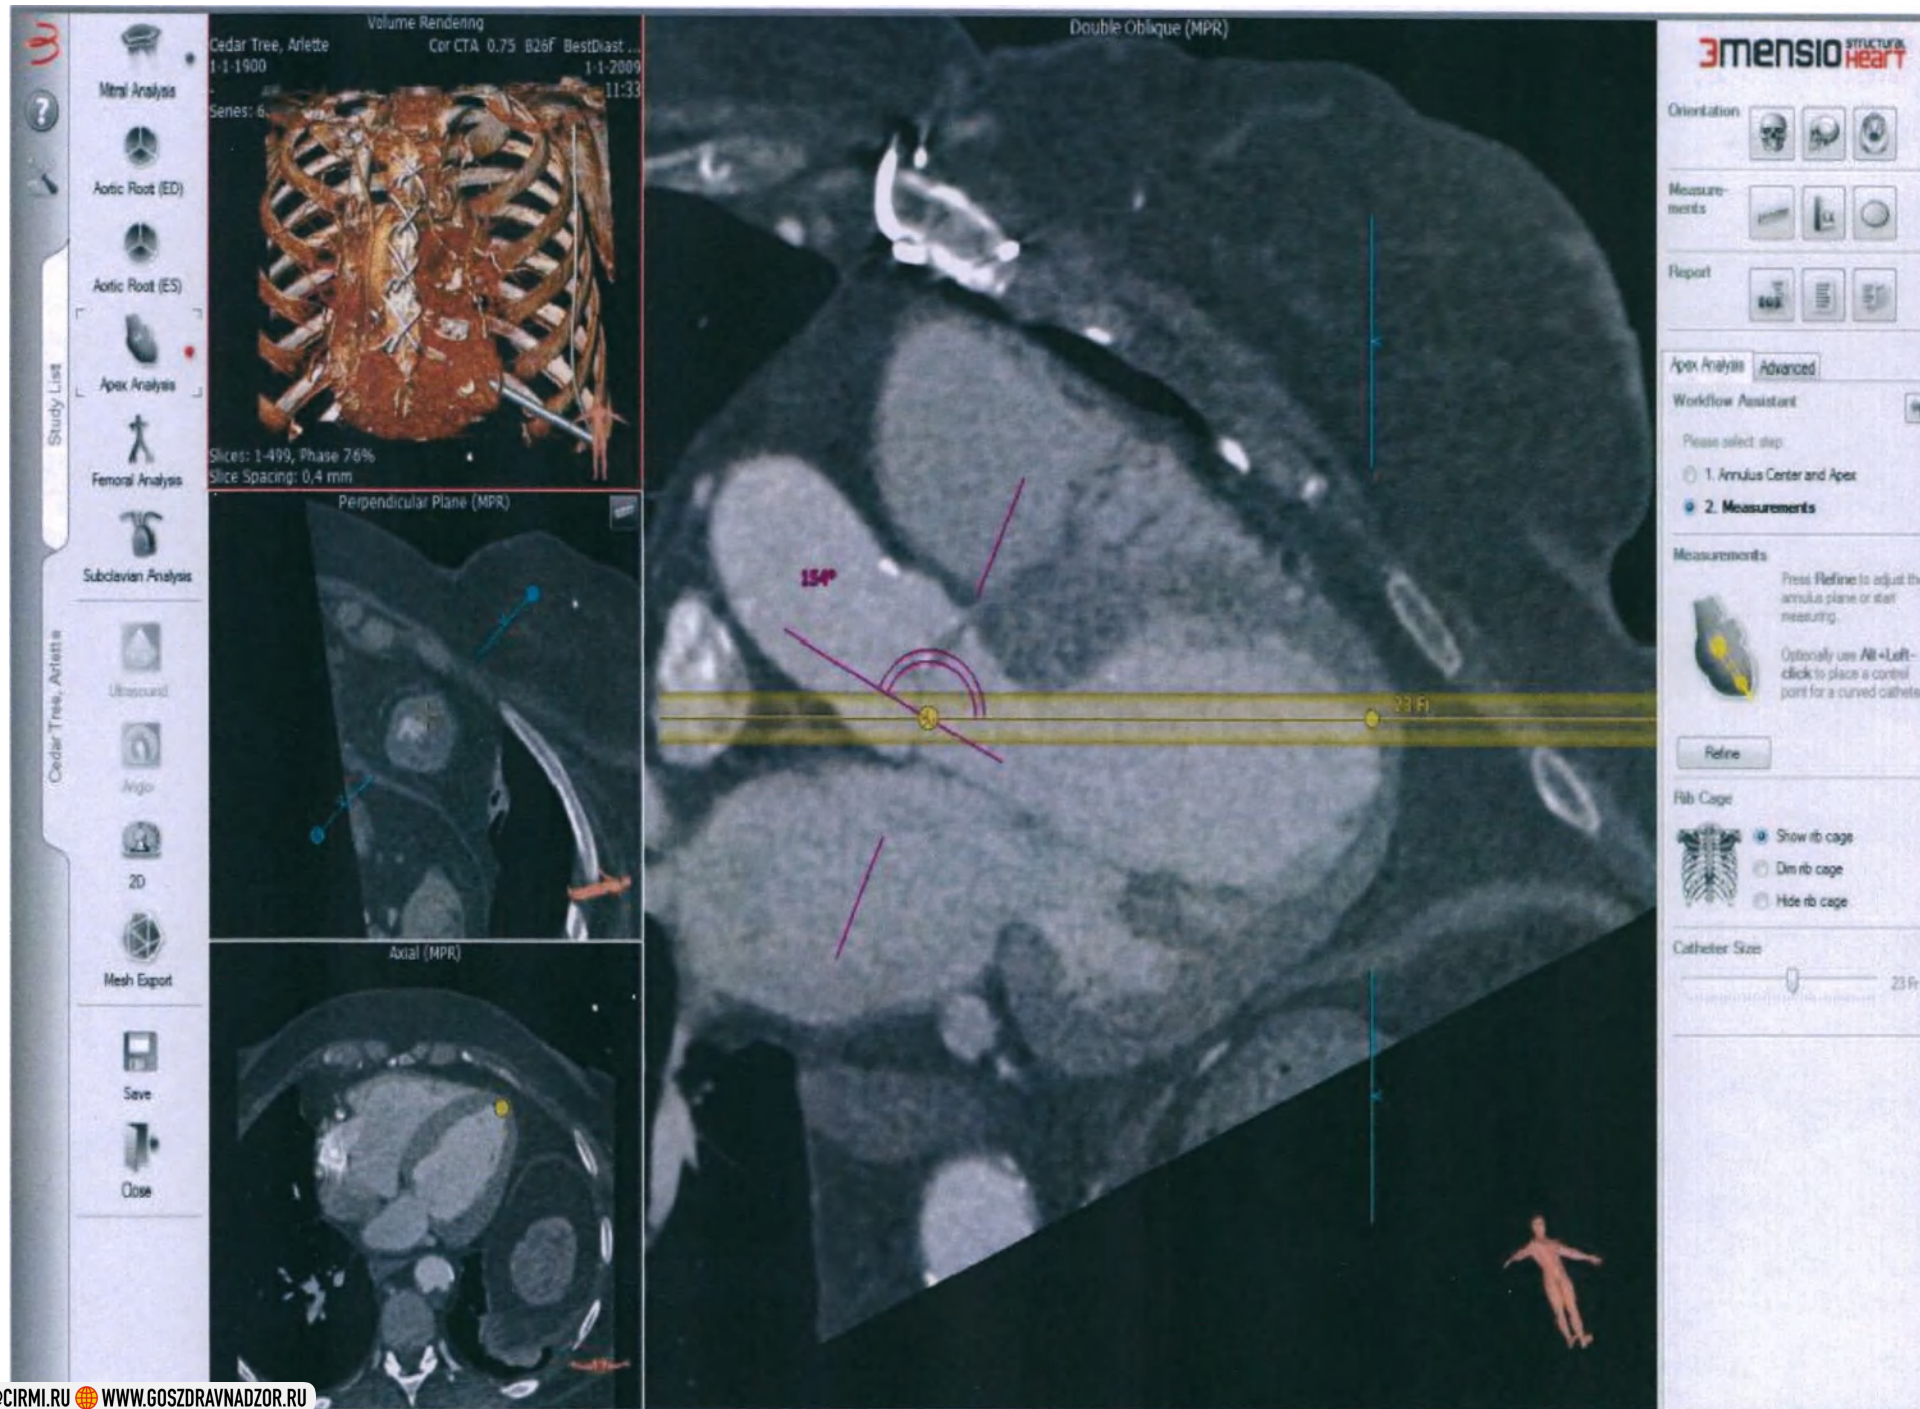


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для поддержки TAVR (3mensio и CAAS A-Valve);

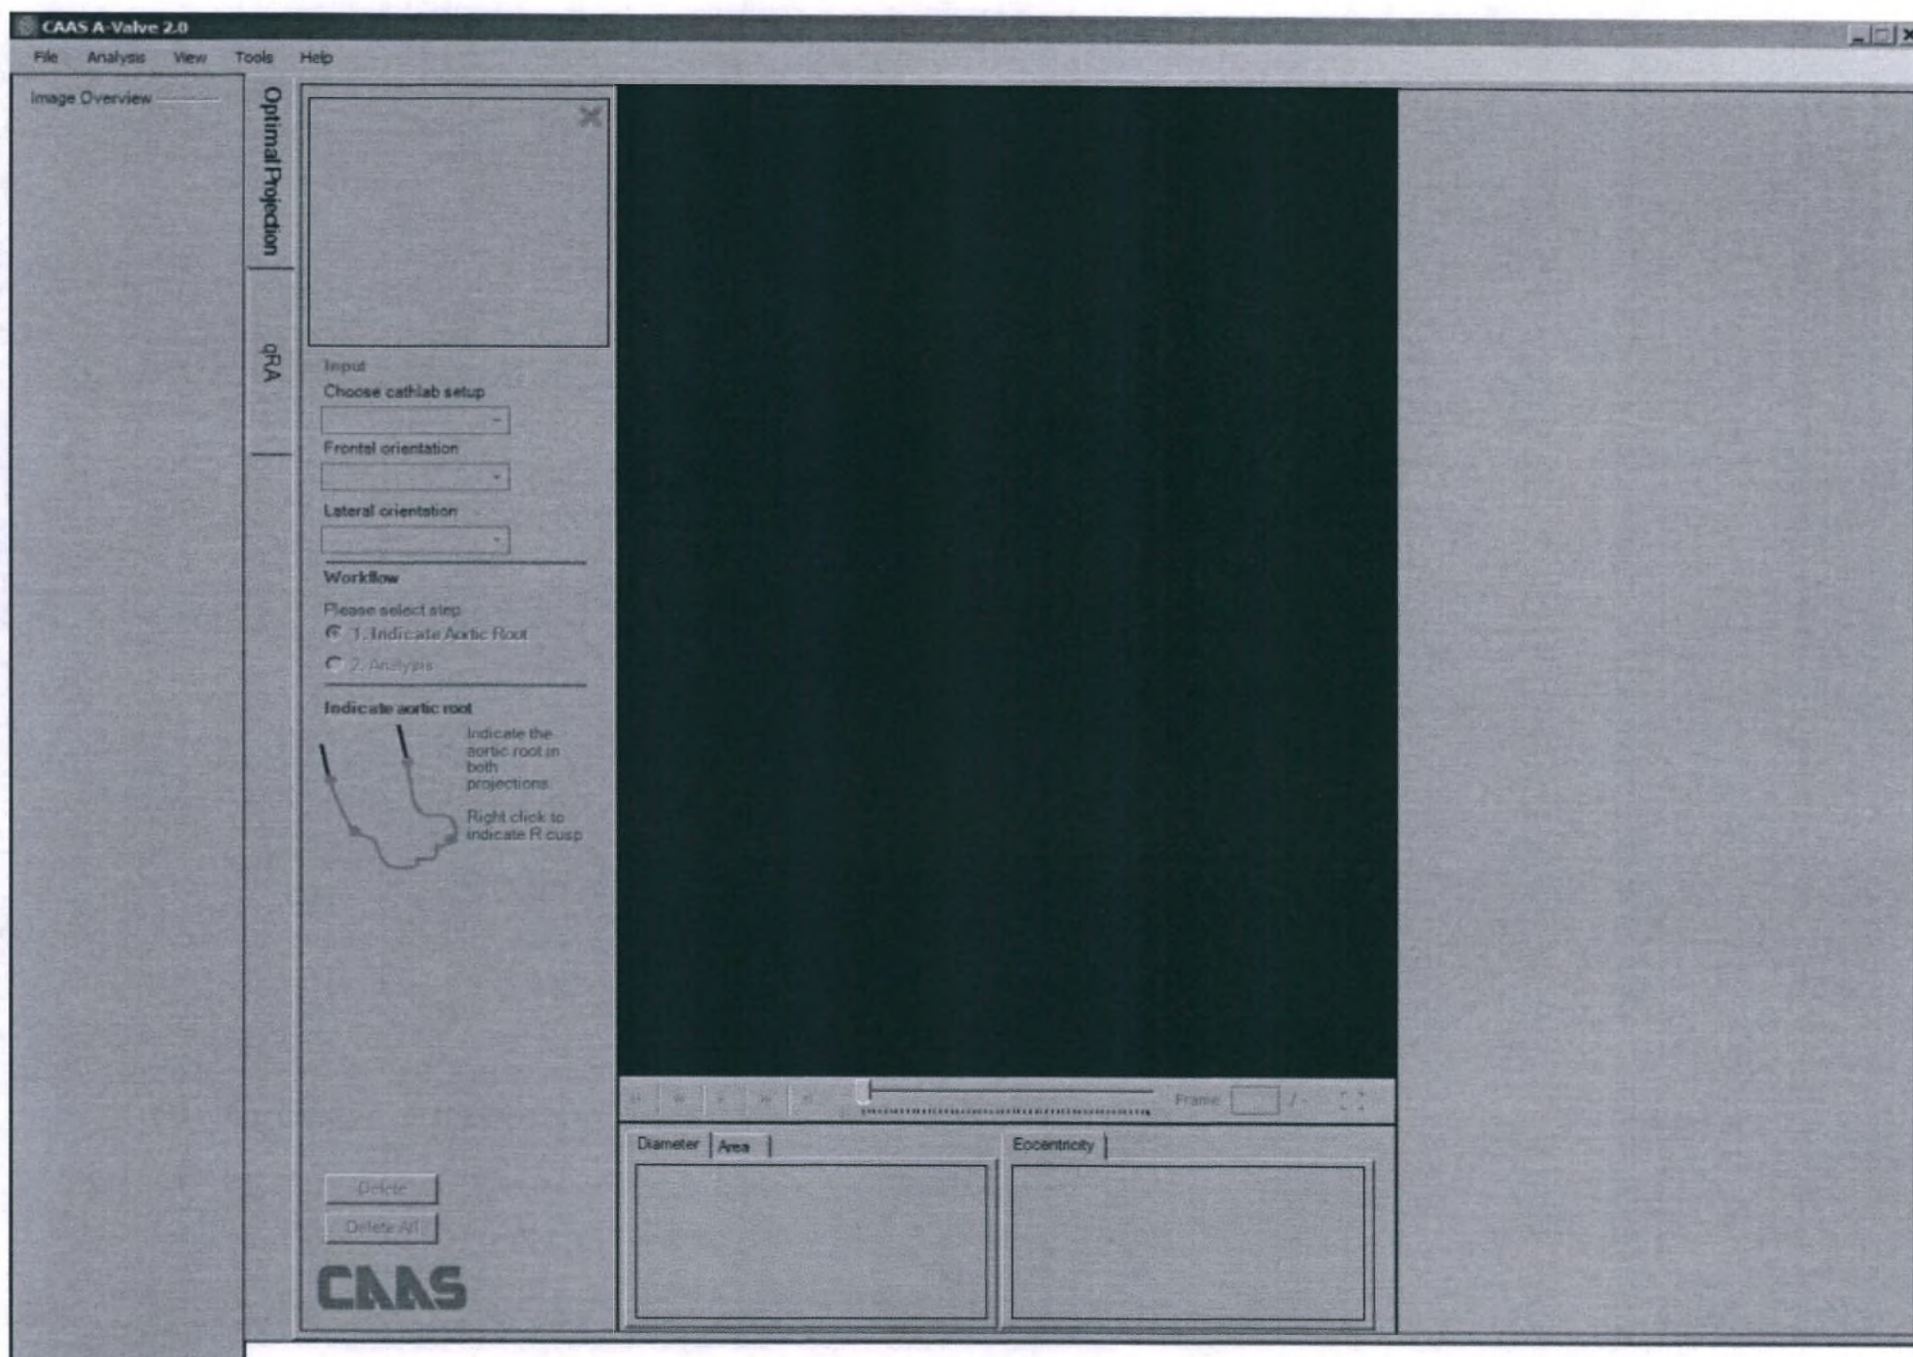


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа митрального клапана;

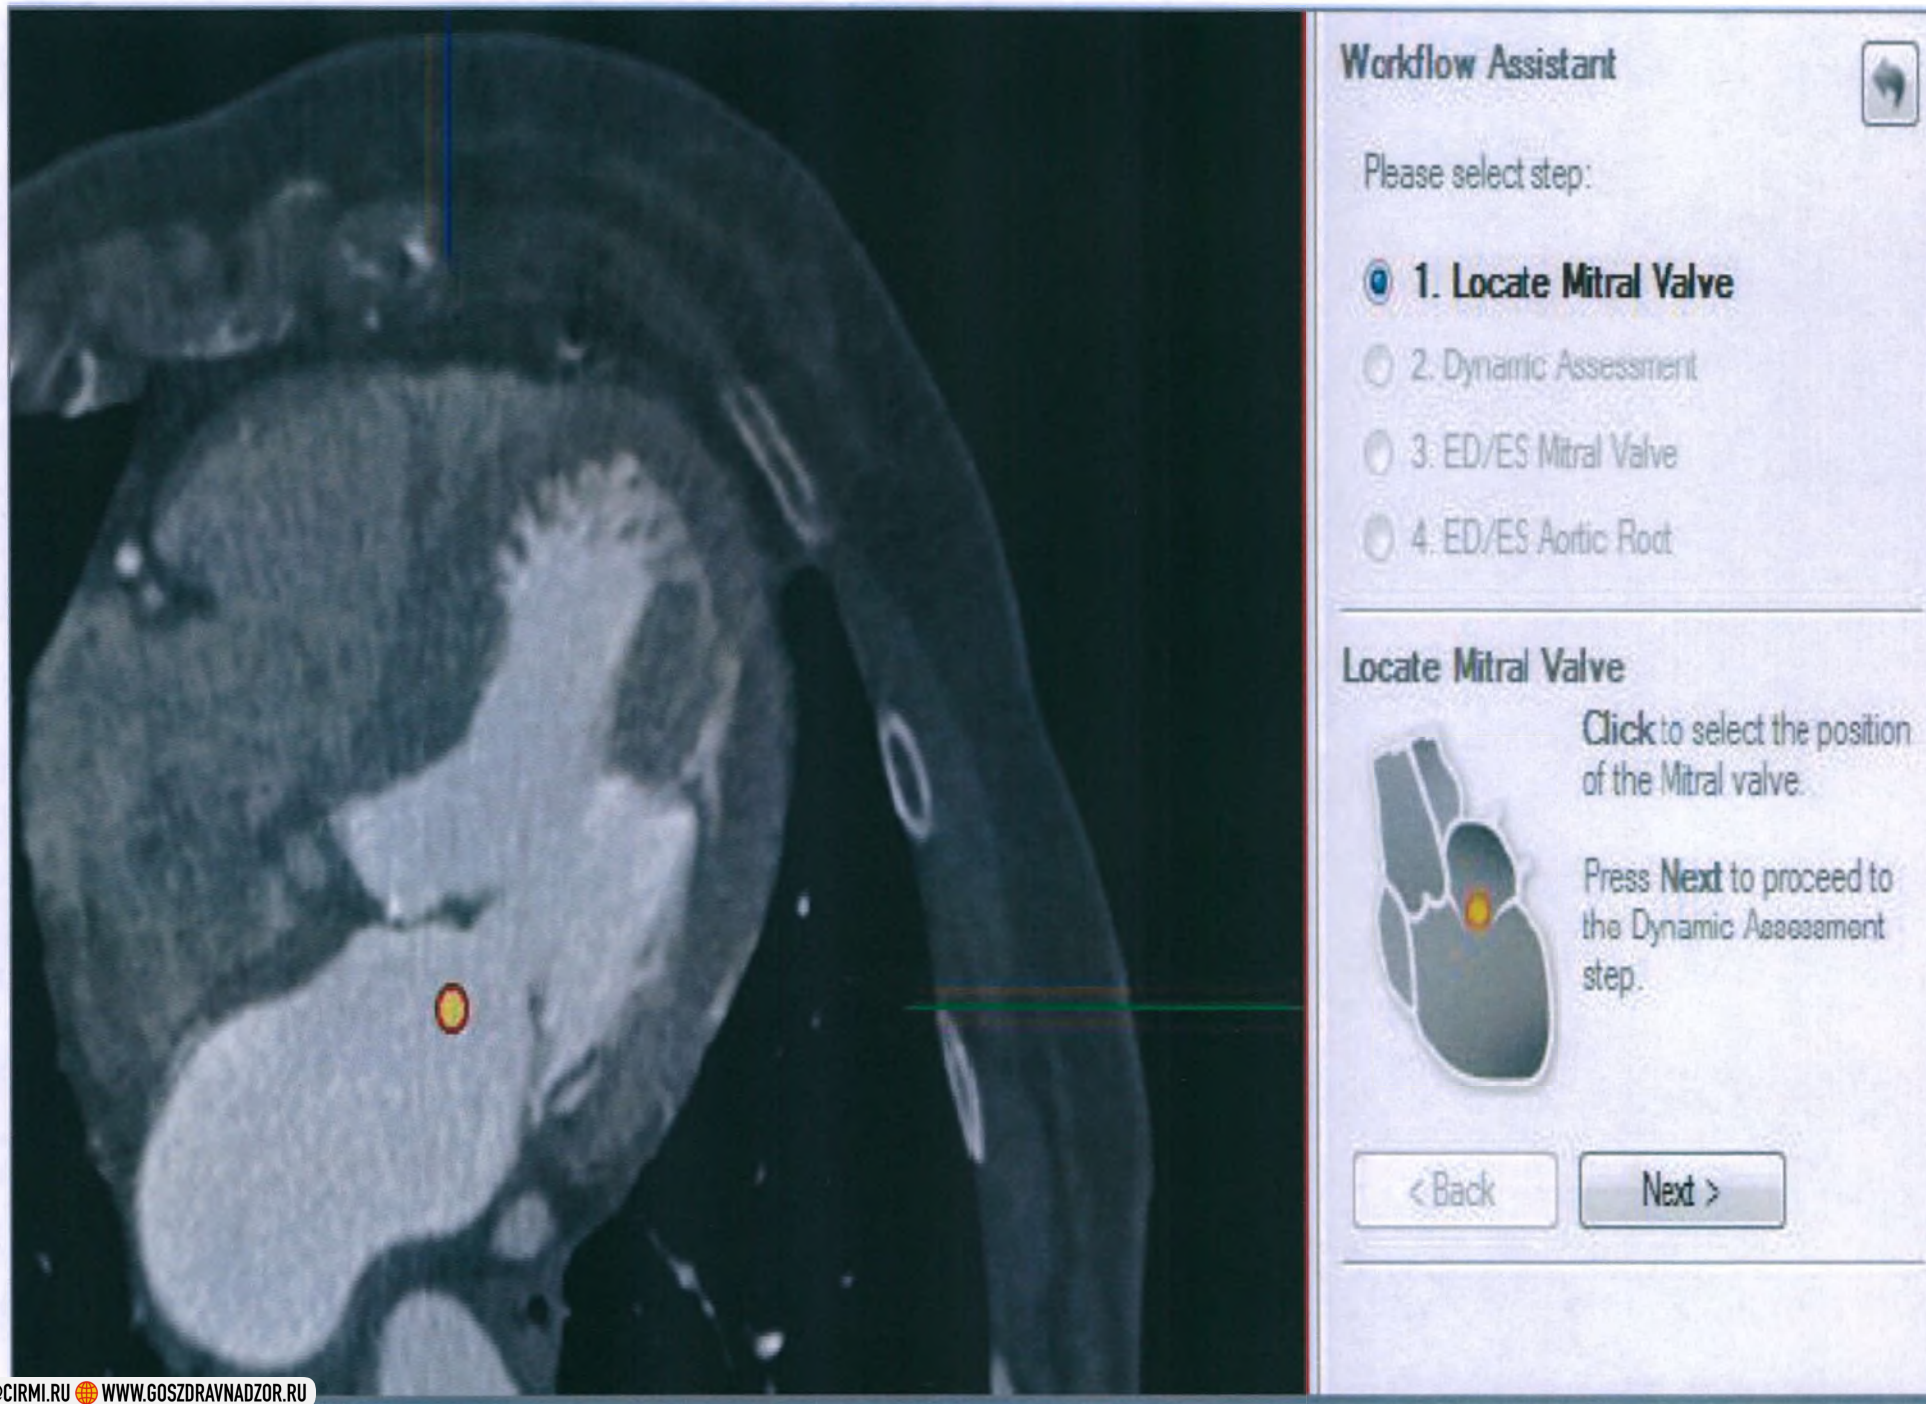


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа ушка левого предсердия;

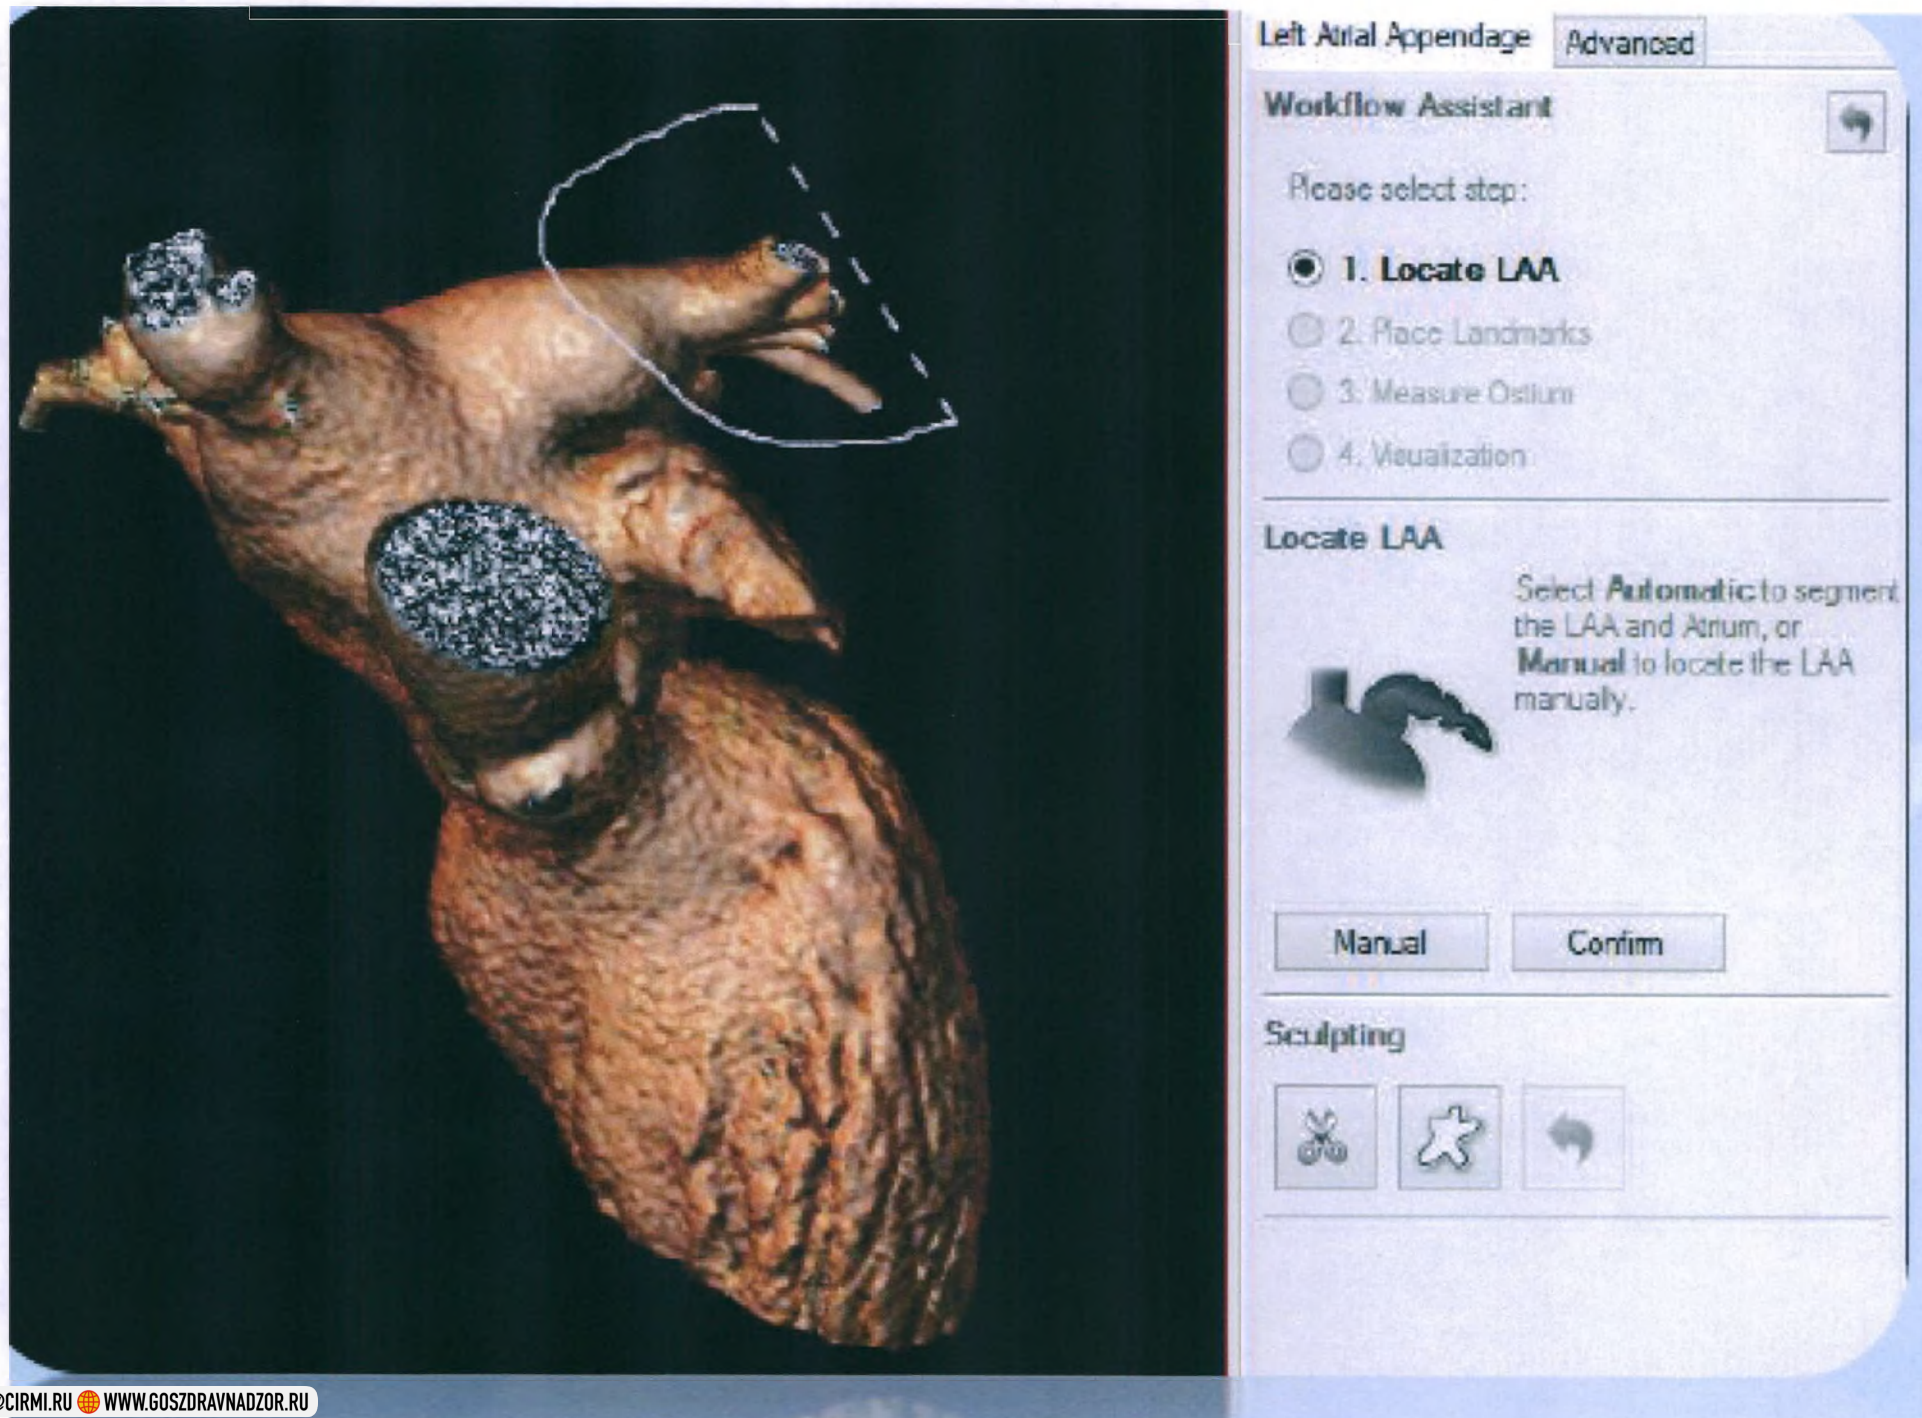

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа регурги-

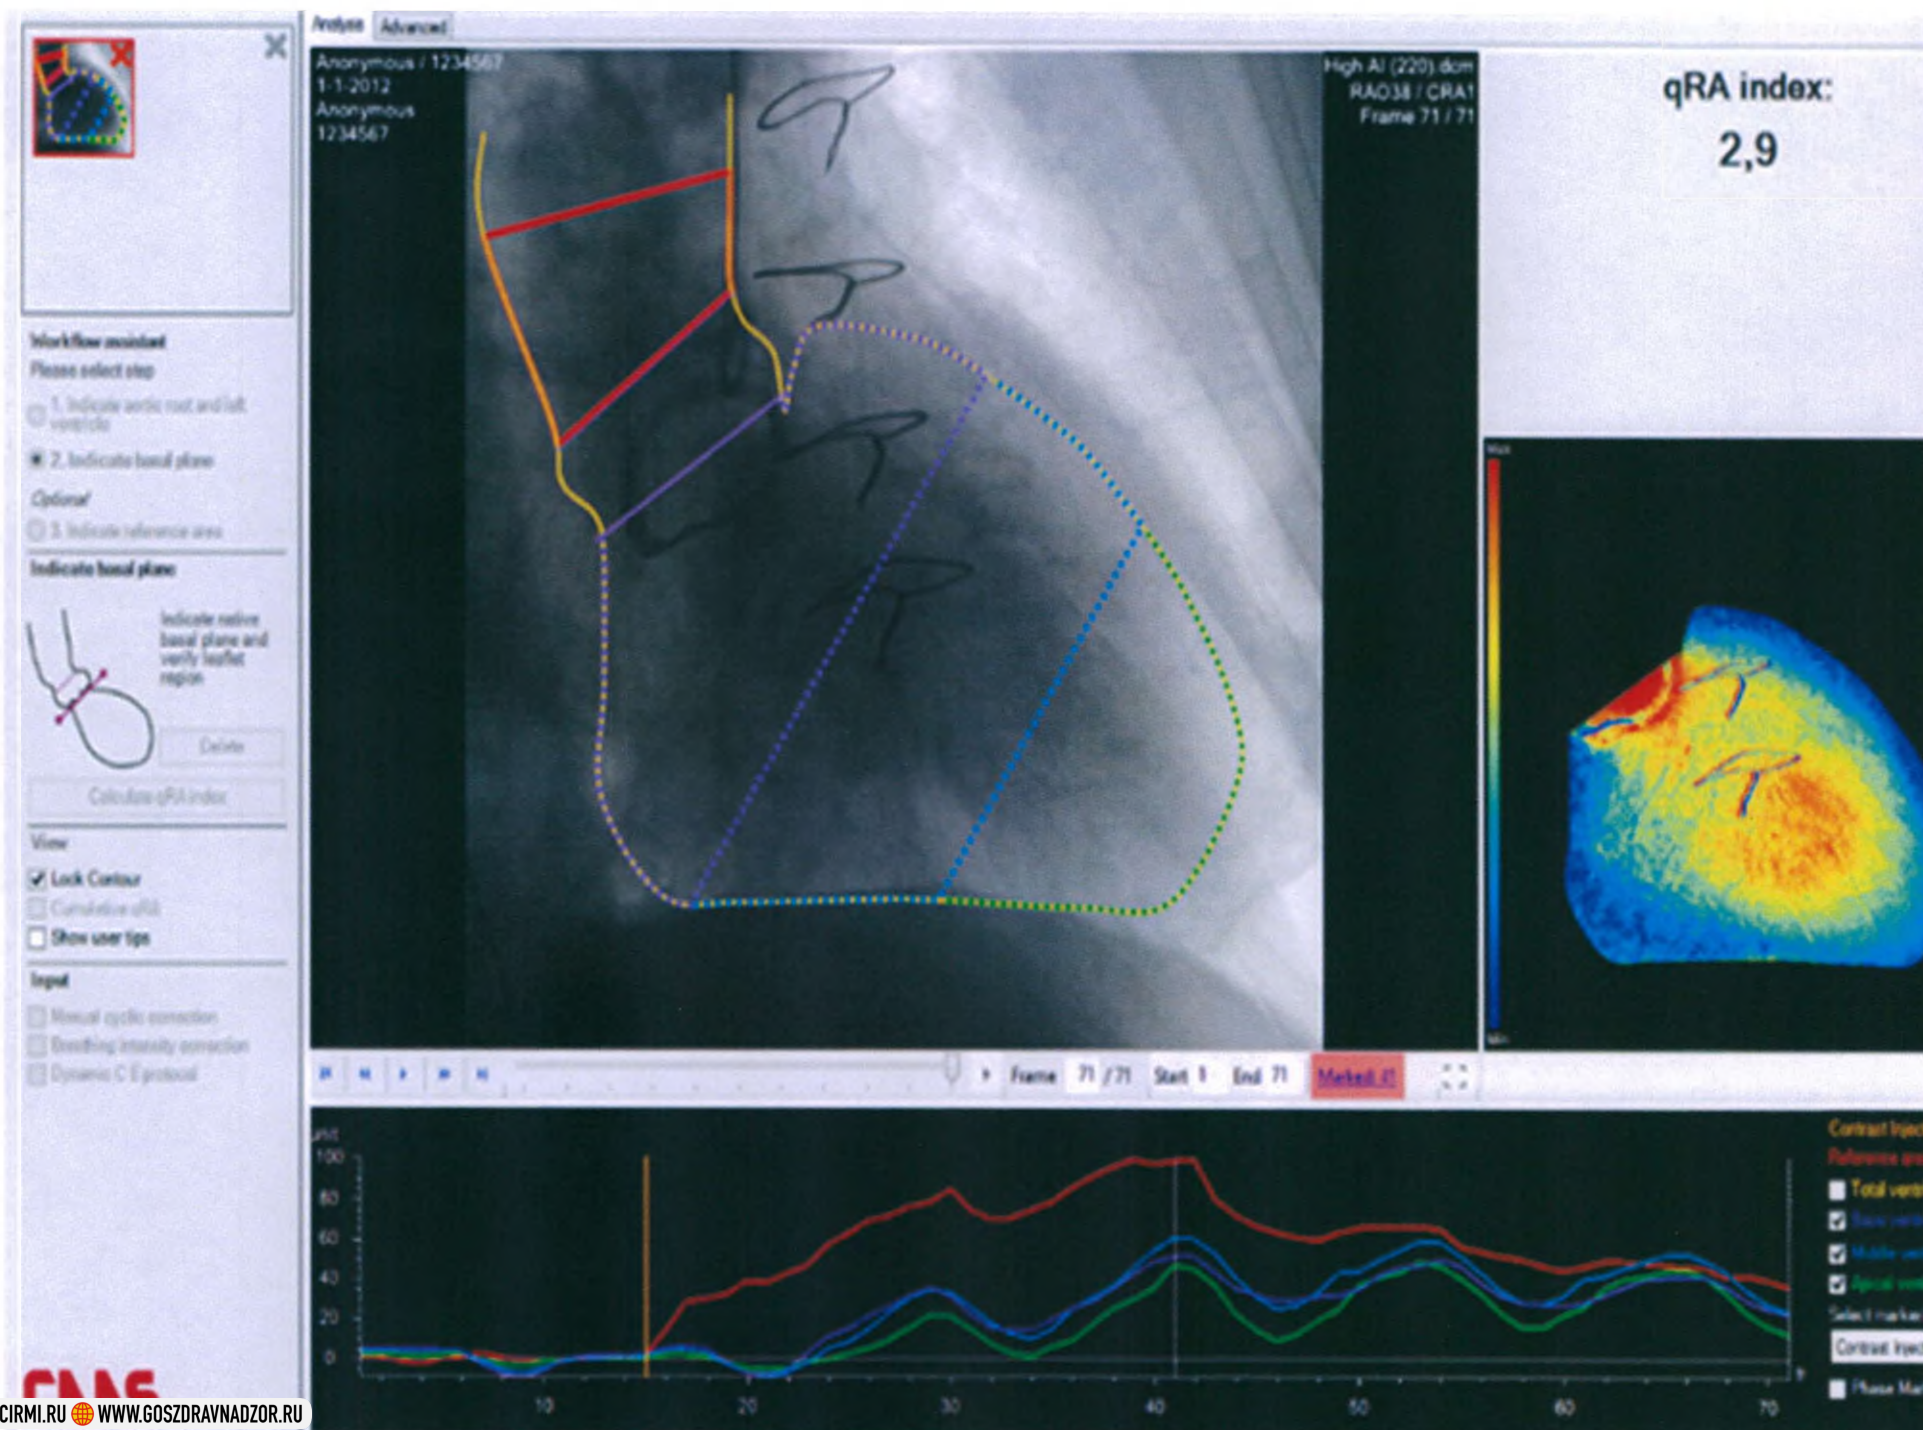


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет DTS для отслеживания дозы;

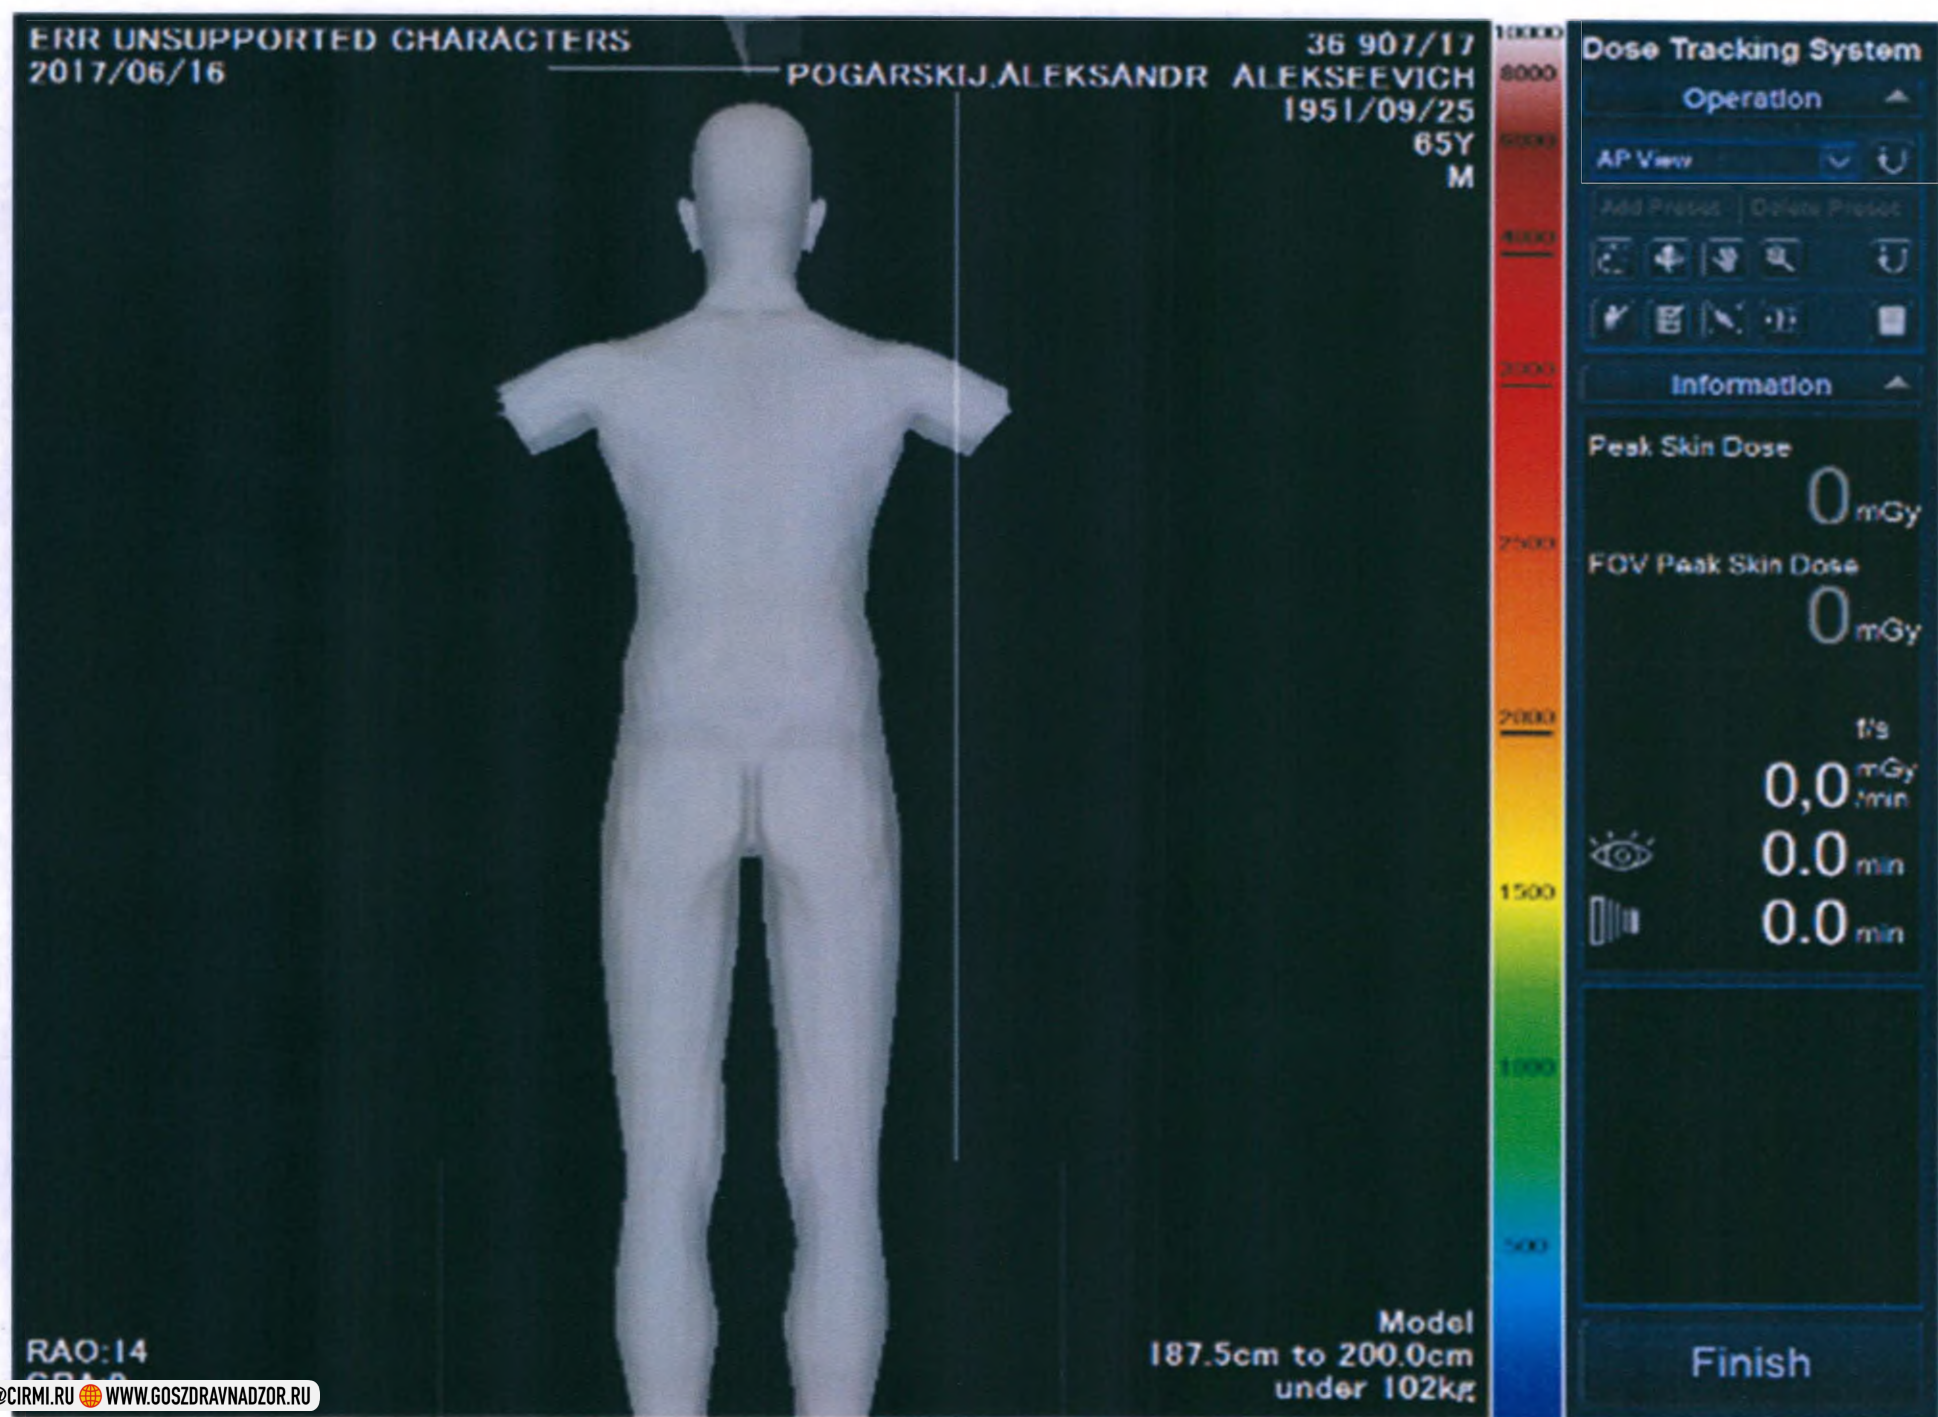

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет динамической стабилизации устройства;




89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа аневризмы сосудов головного мозга;

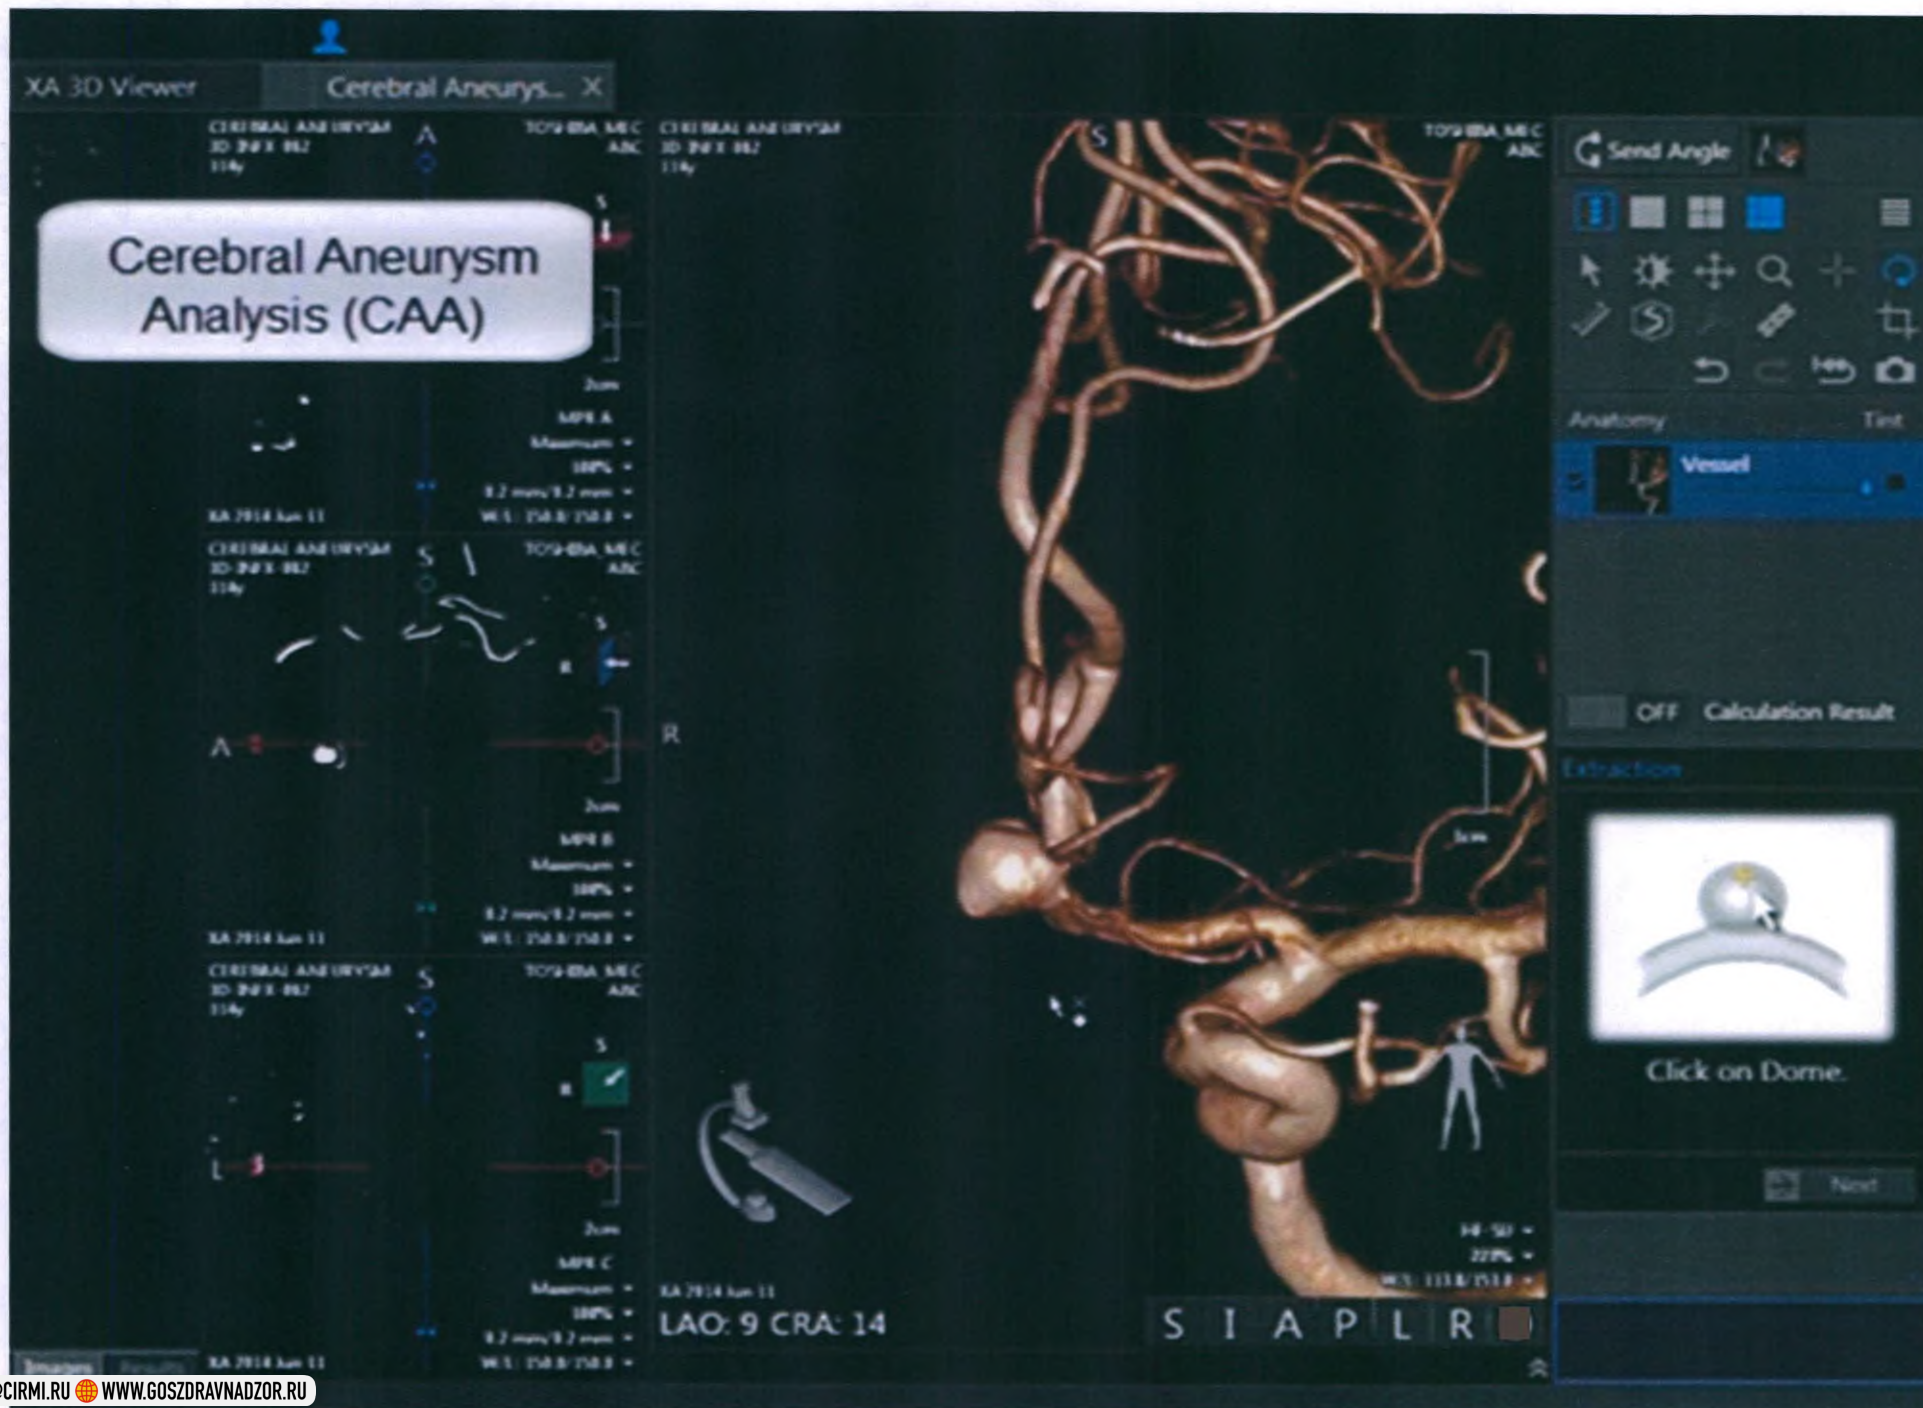


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для планирования эмболизации;



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет инструментов 3D-просмотра.

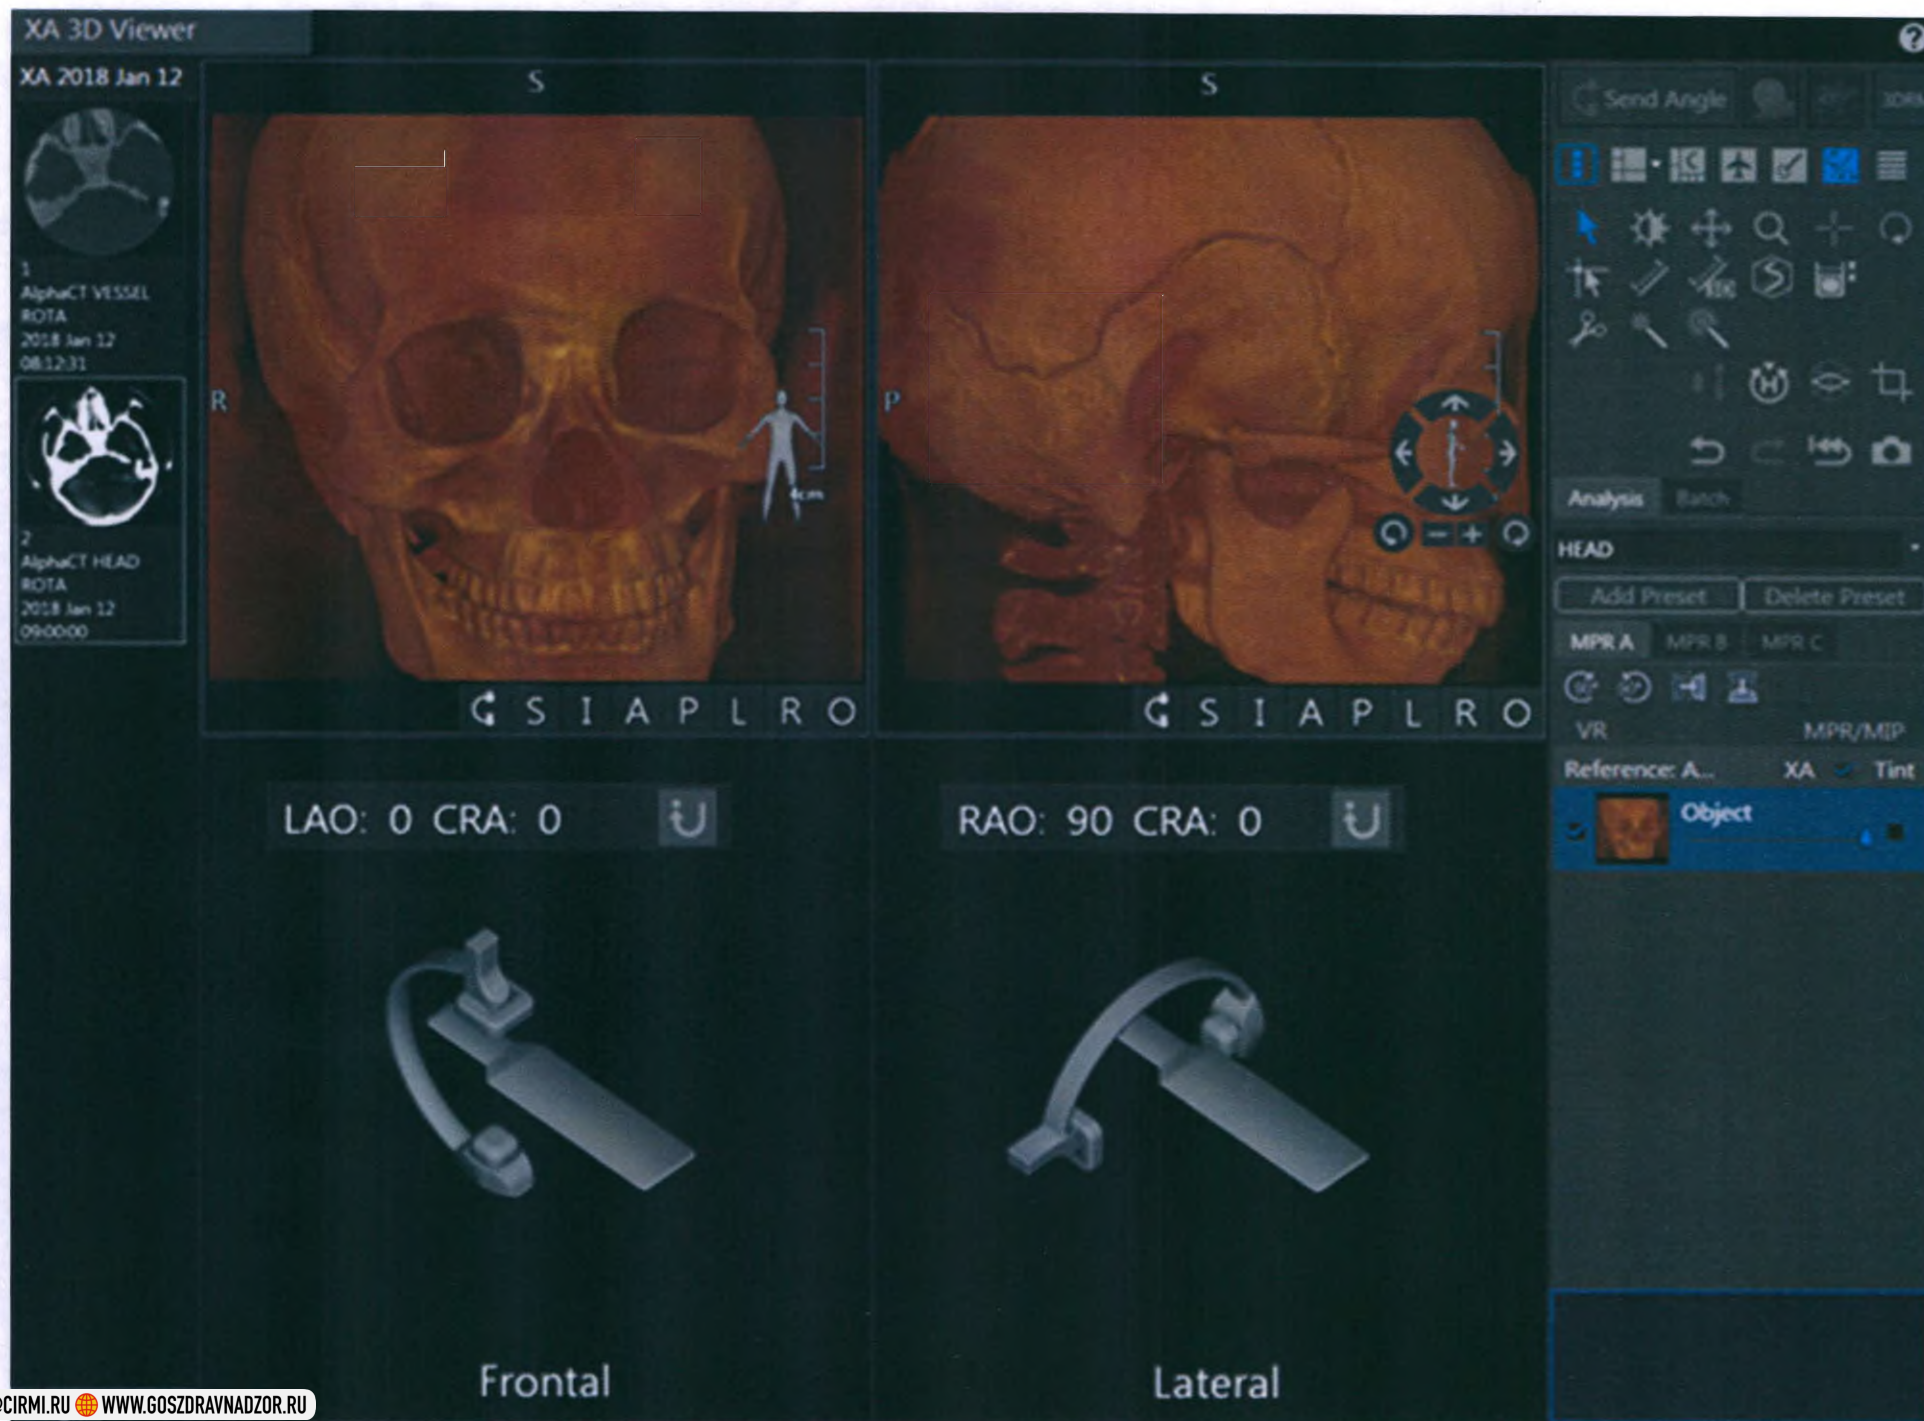

90. Комплект для подключения Rocket Link.

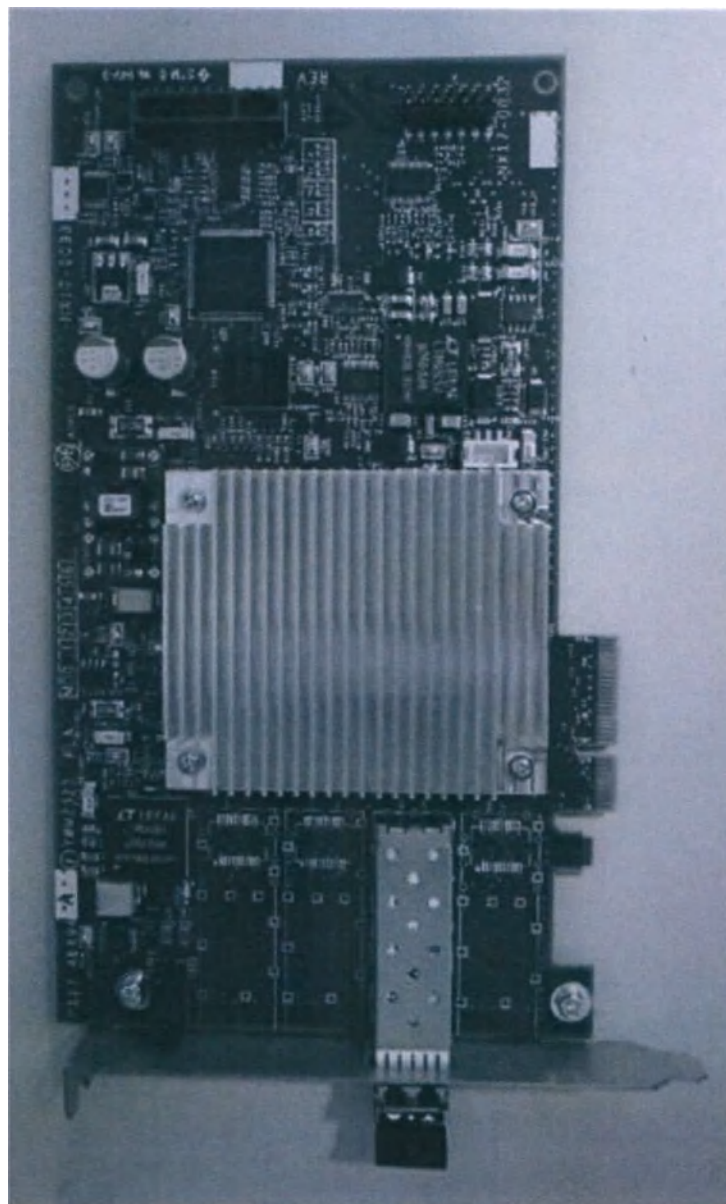





92. Стойка для охладителя.



93. Стойка для монитора с большим экраном.

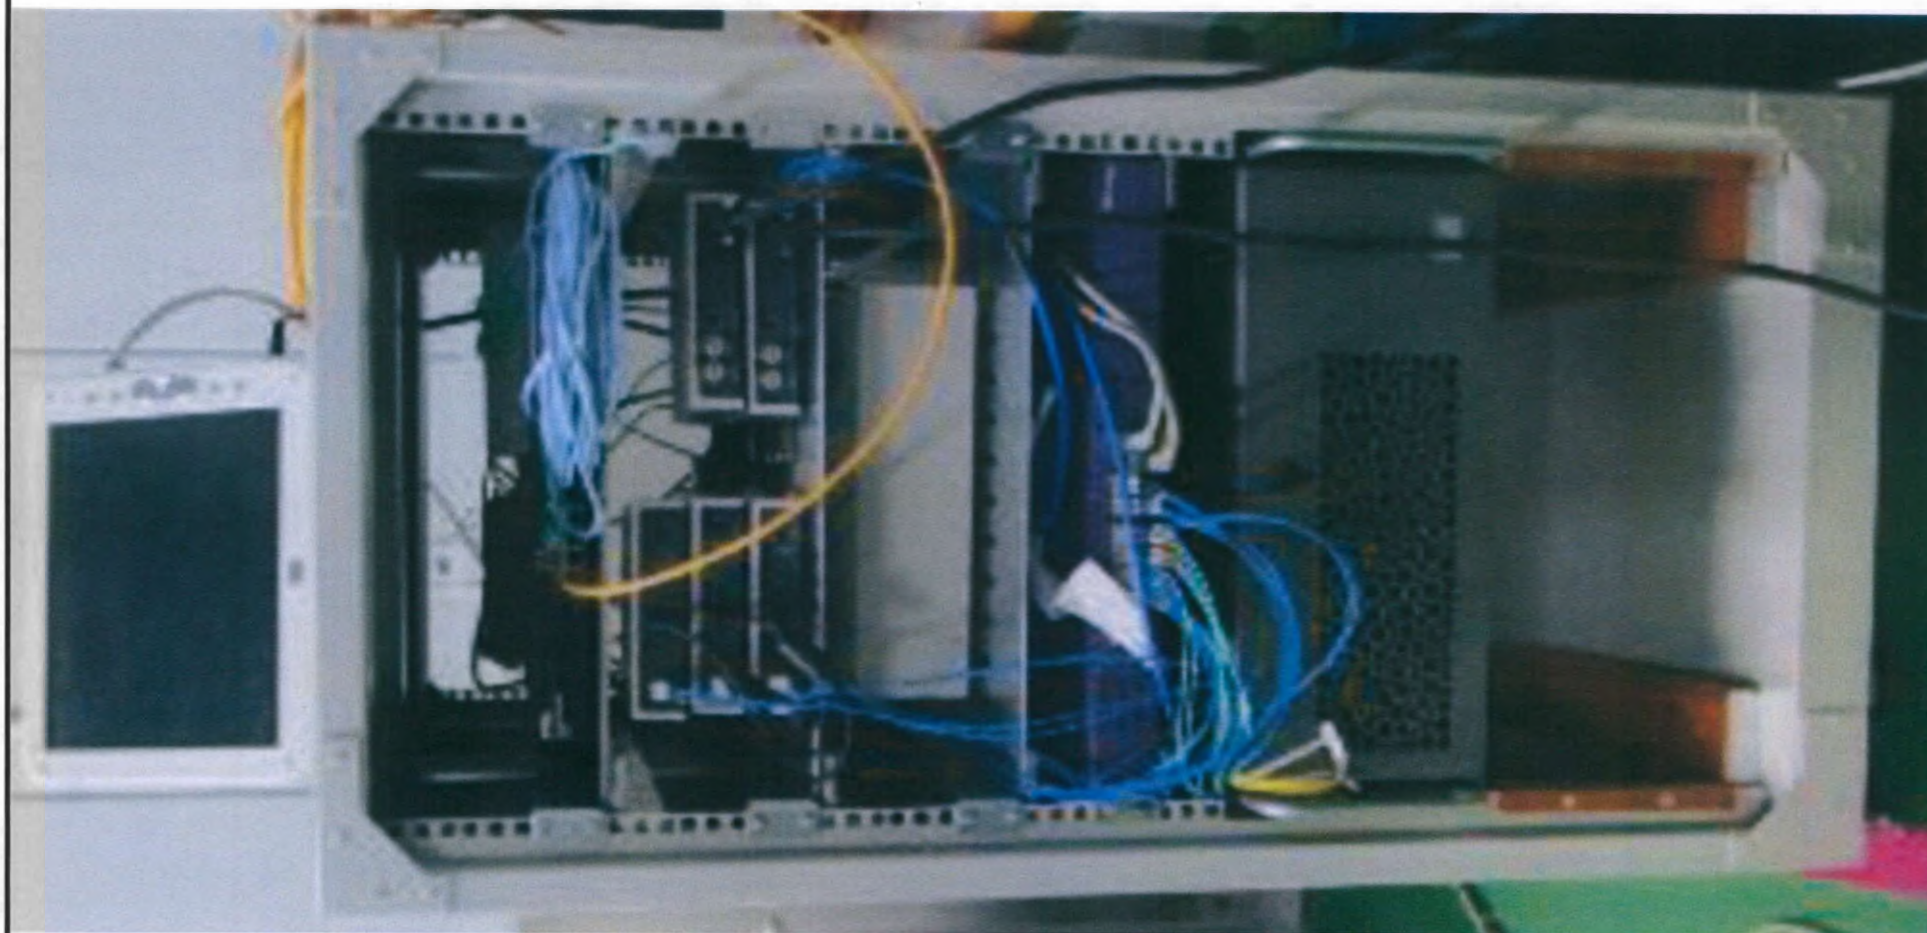




94. Модуль для подключения ИБП.

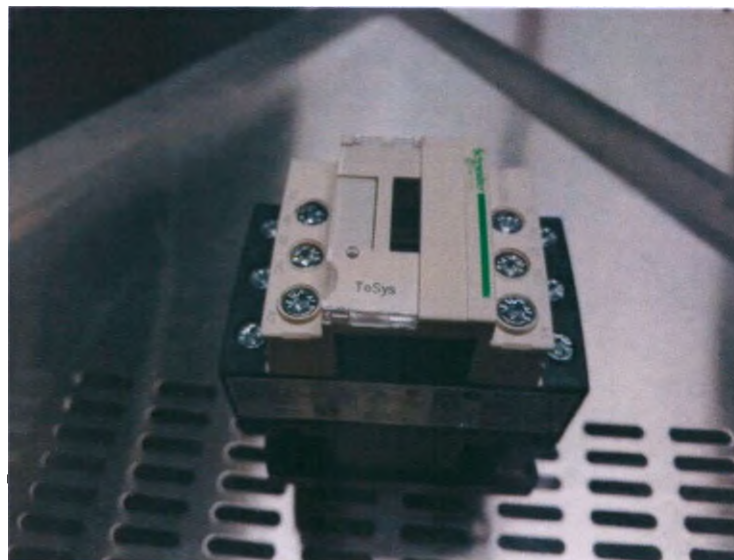

Контактор




Пневматический таймер

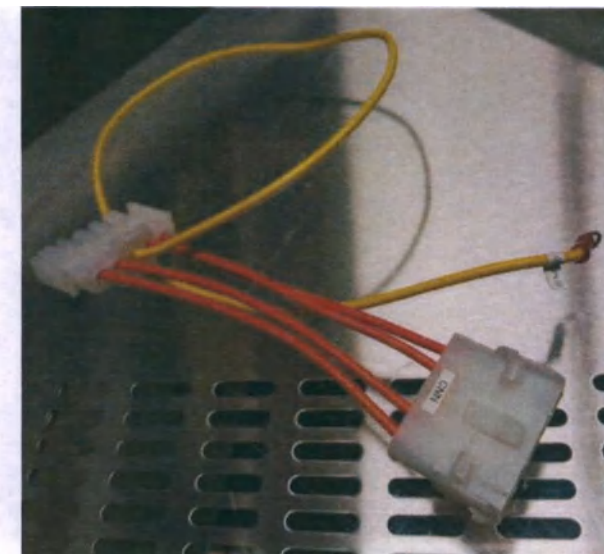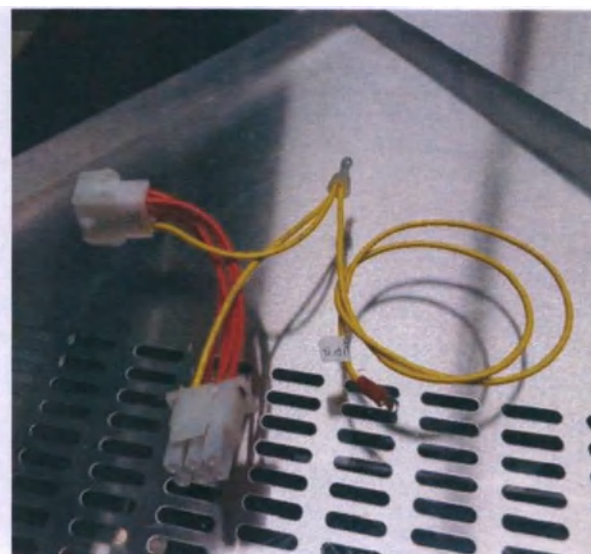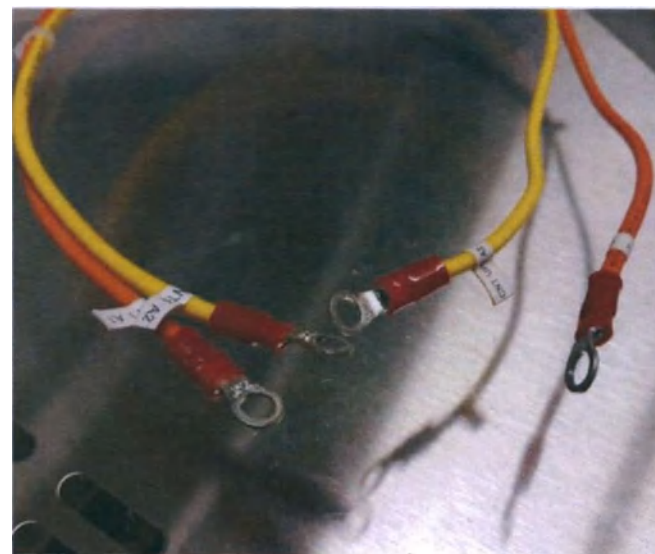

Соединительные кабели





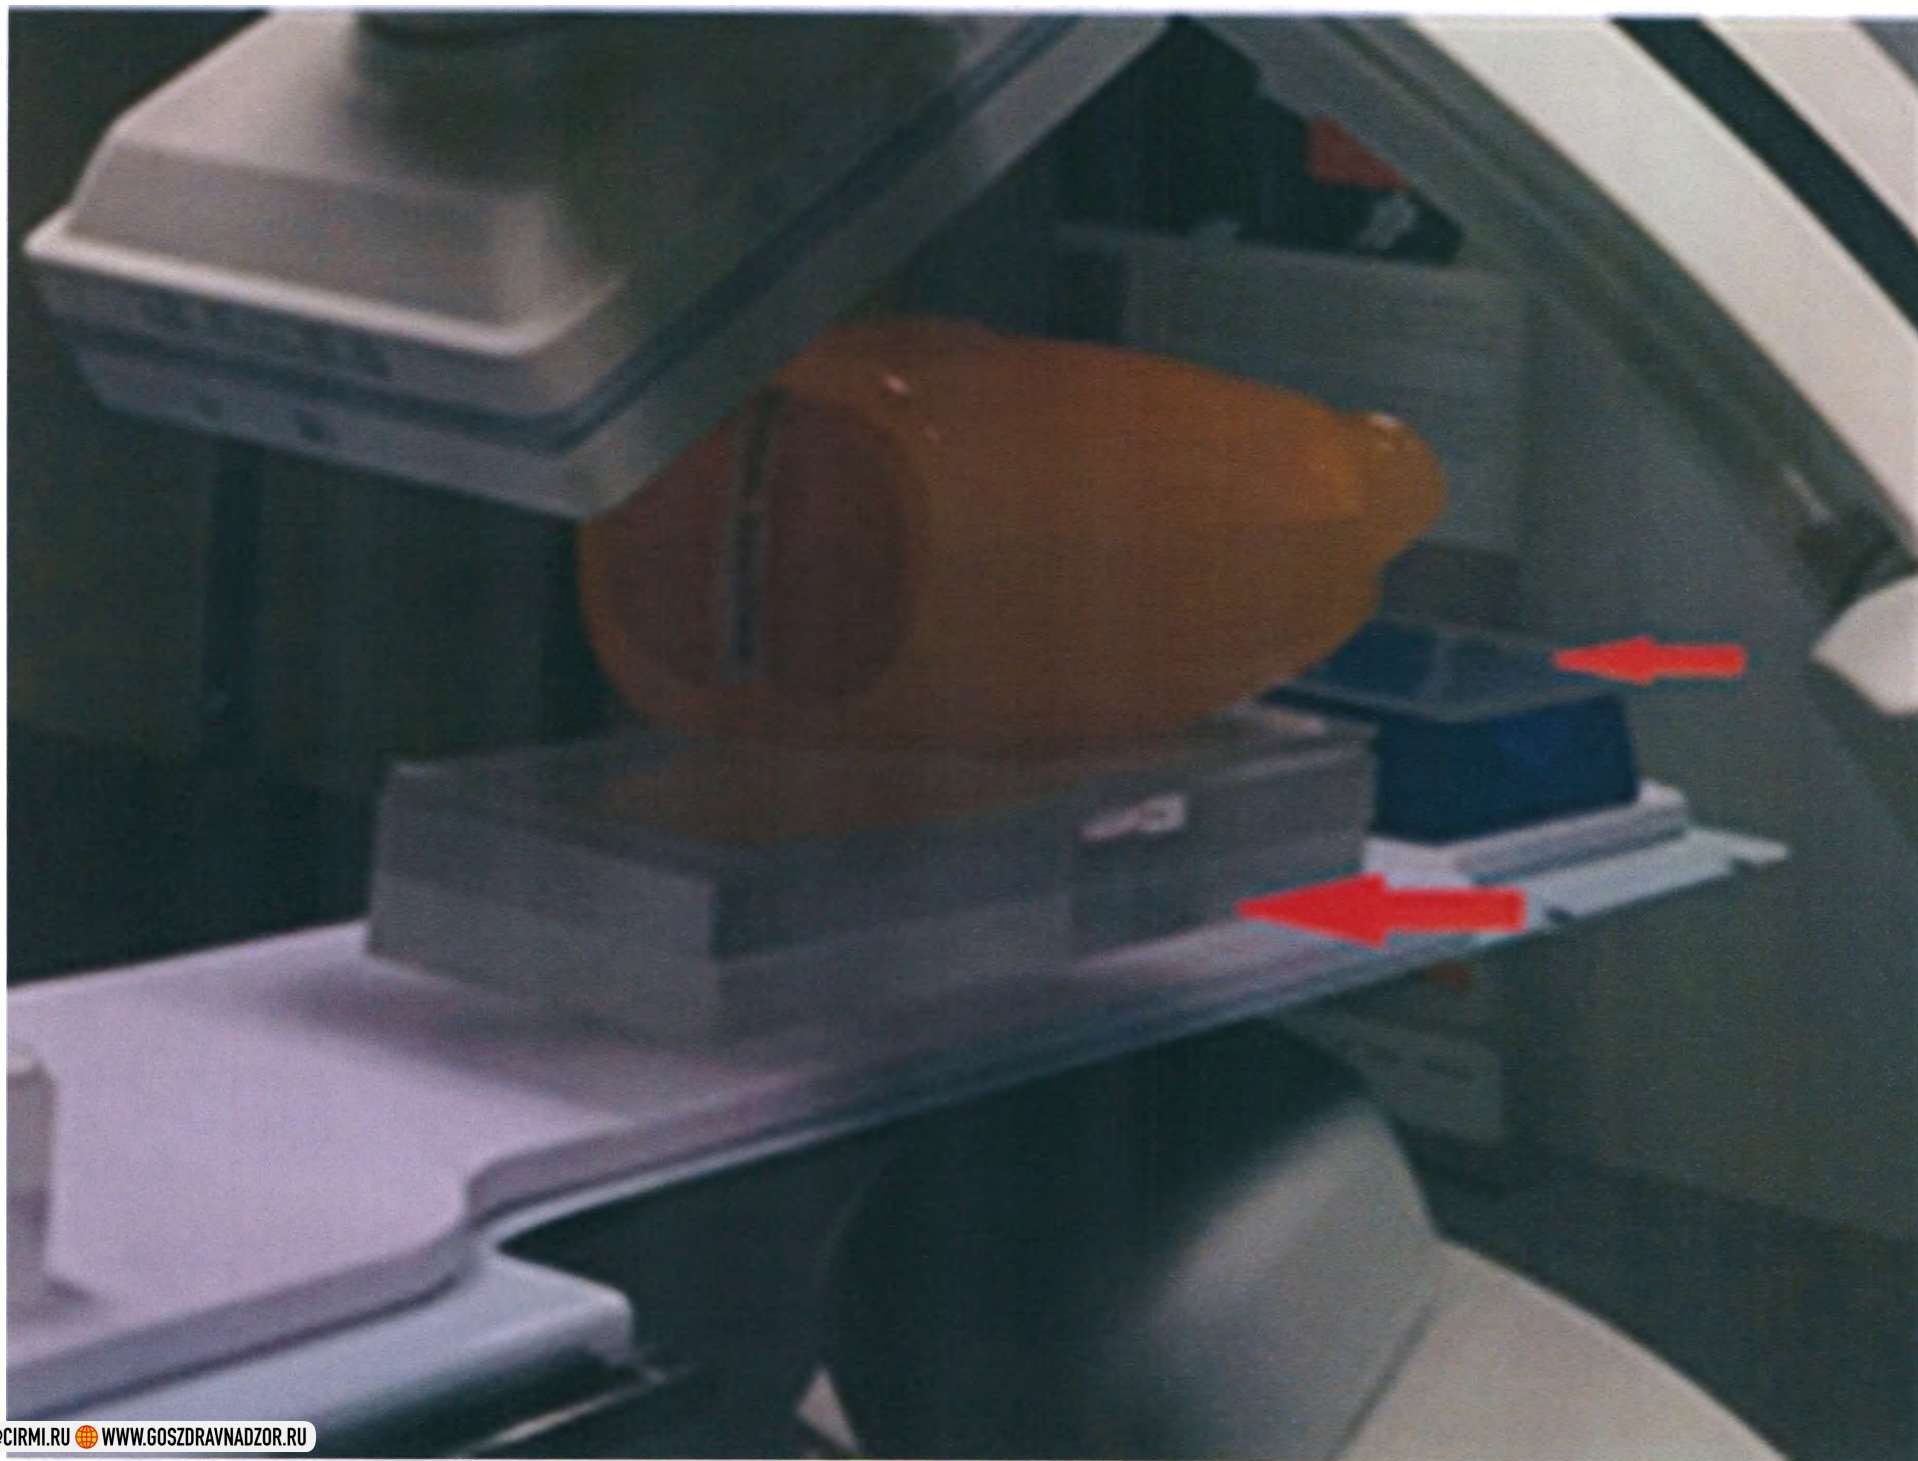


Система сосудистая SP интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями .


Основной состав: 1. Напольный опорный модуль С-дуги модели CAS-880A.




2. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, в вариантах исполнения: - модель BLA-900A,

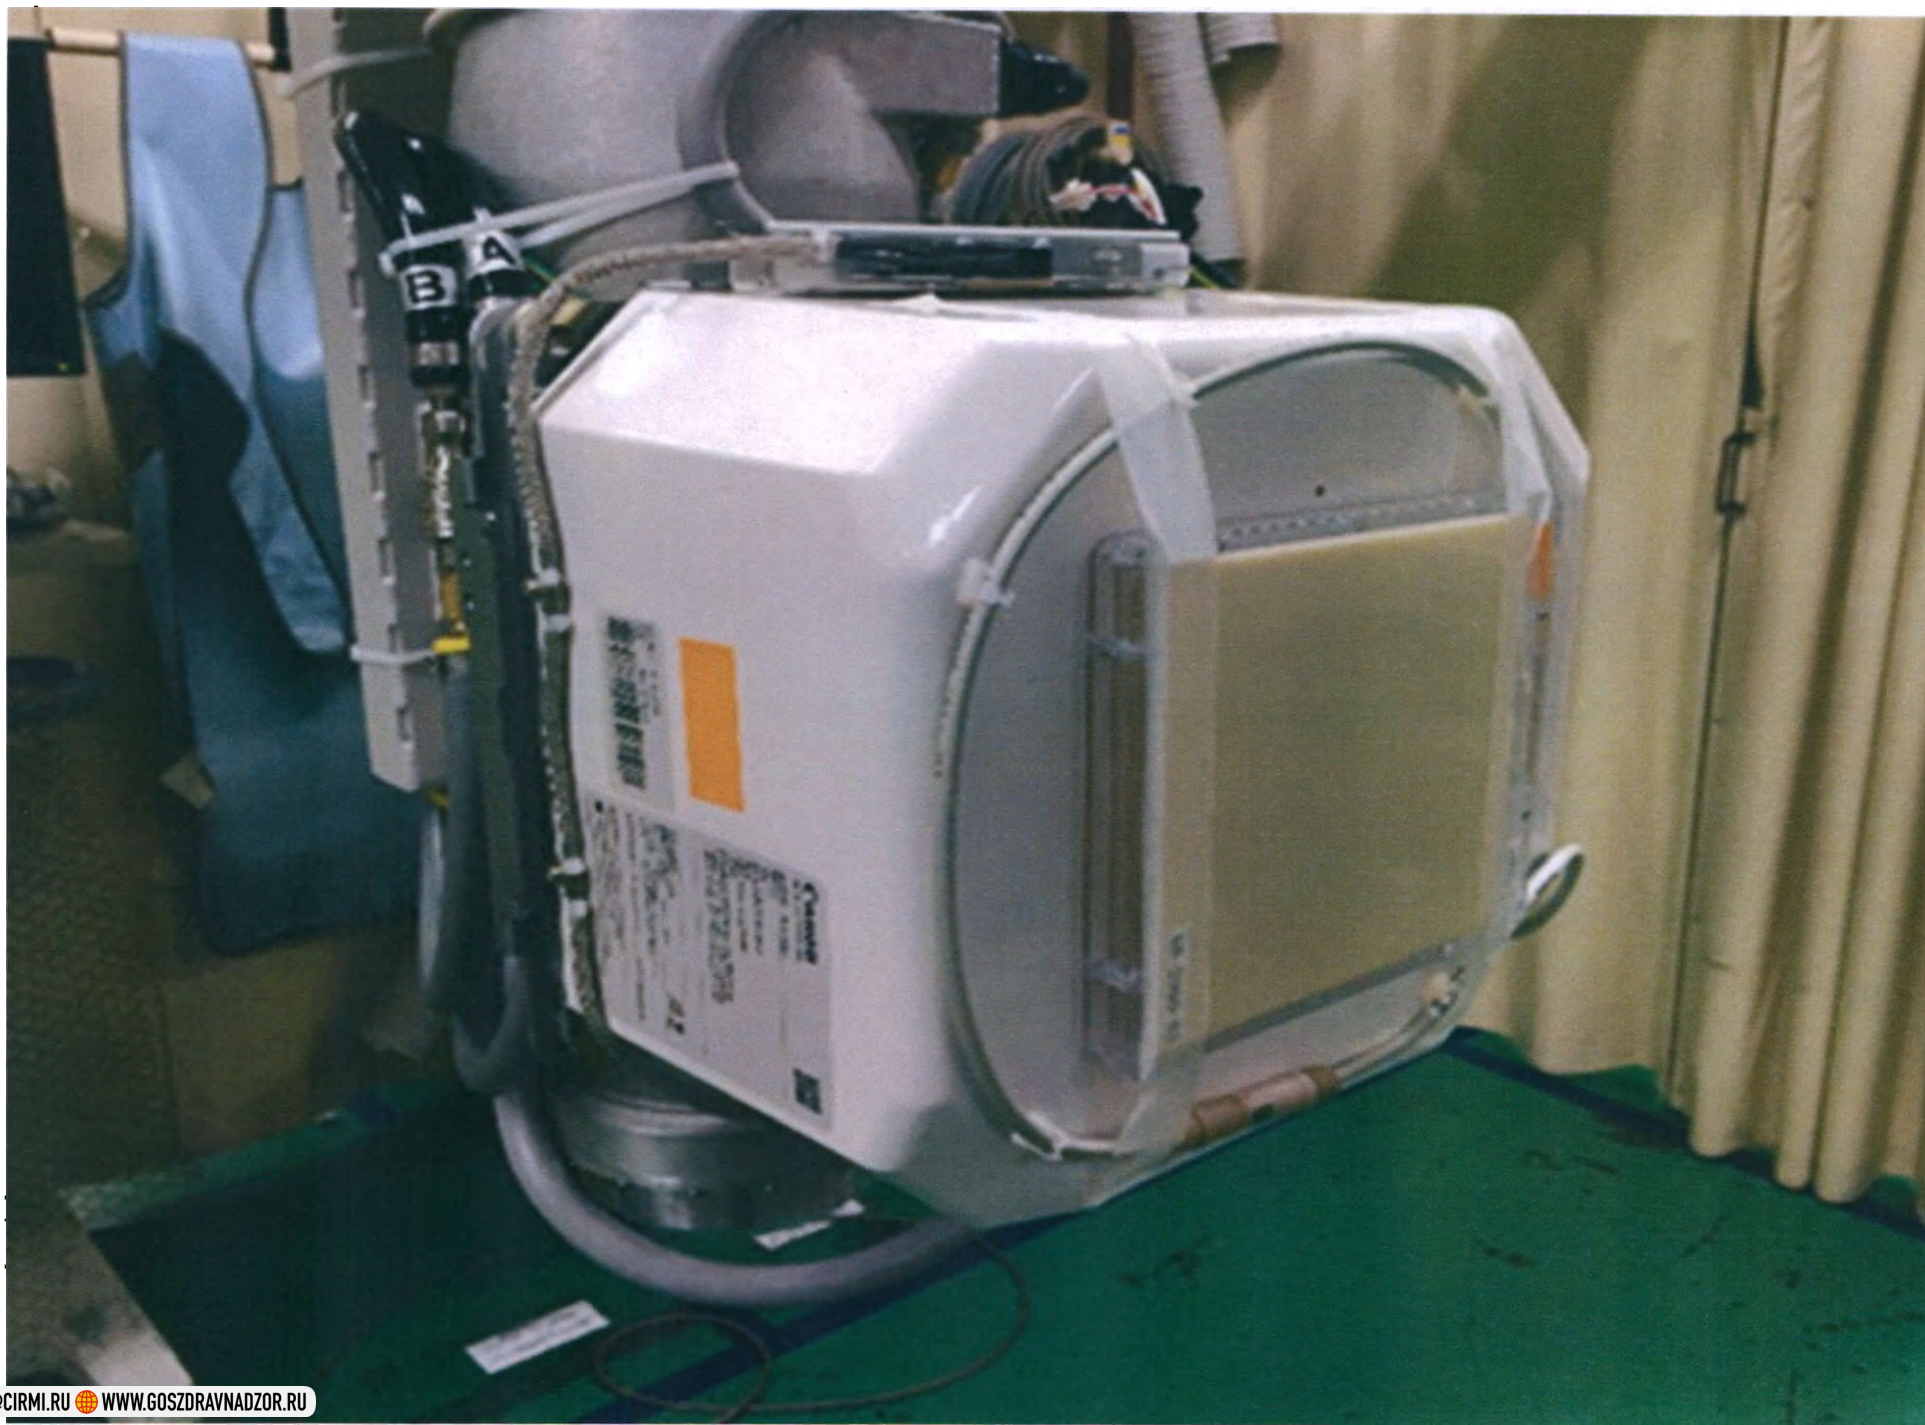


2. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, в вариантах исполнения: - модель BLA-900A/R1.

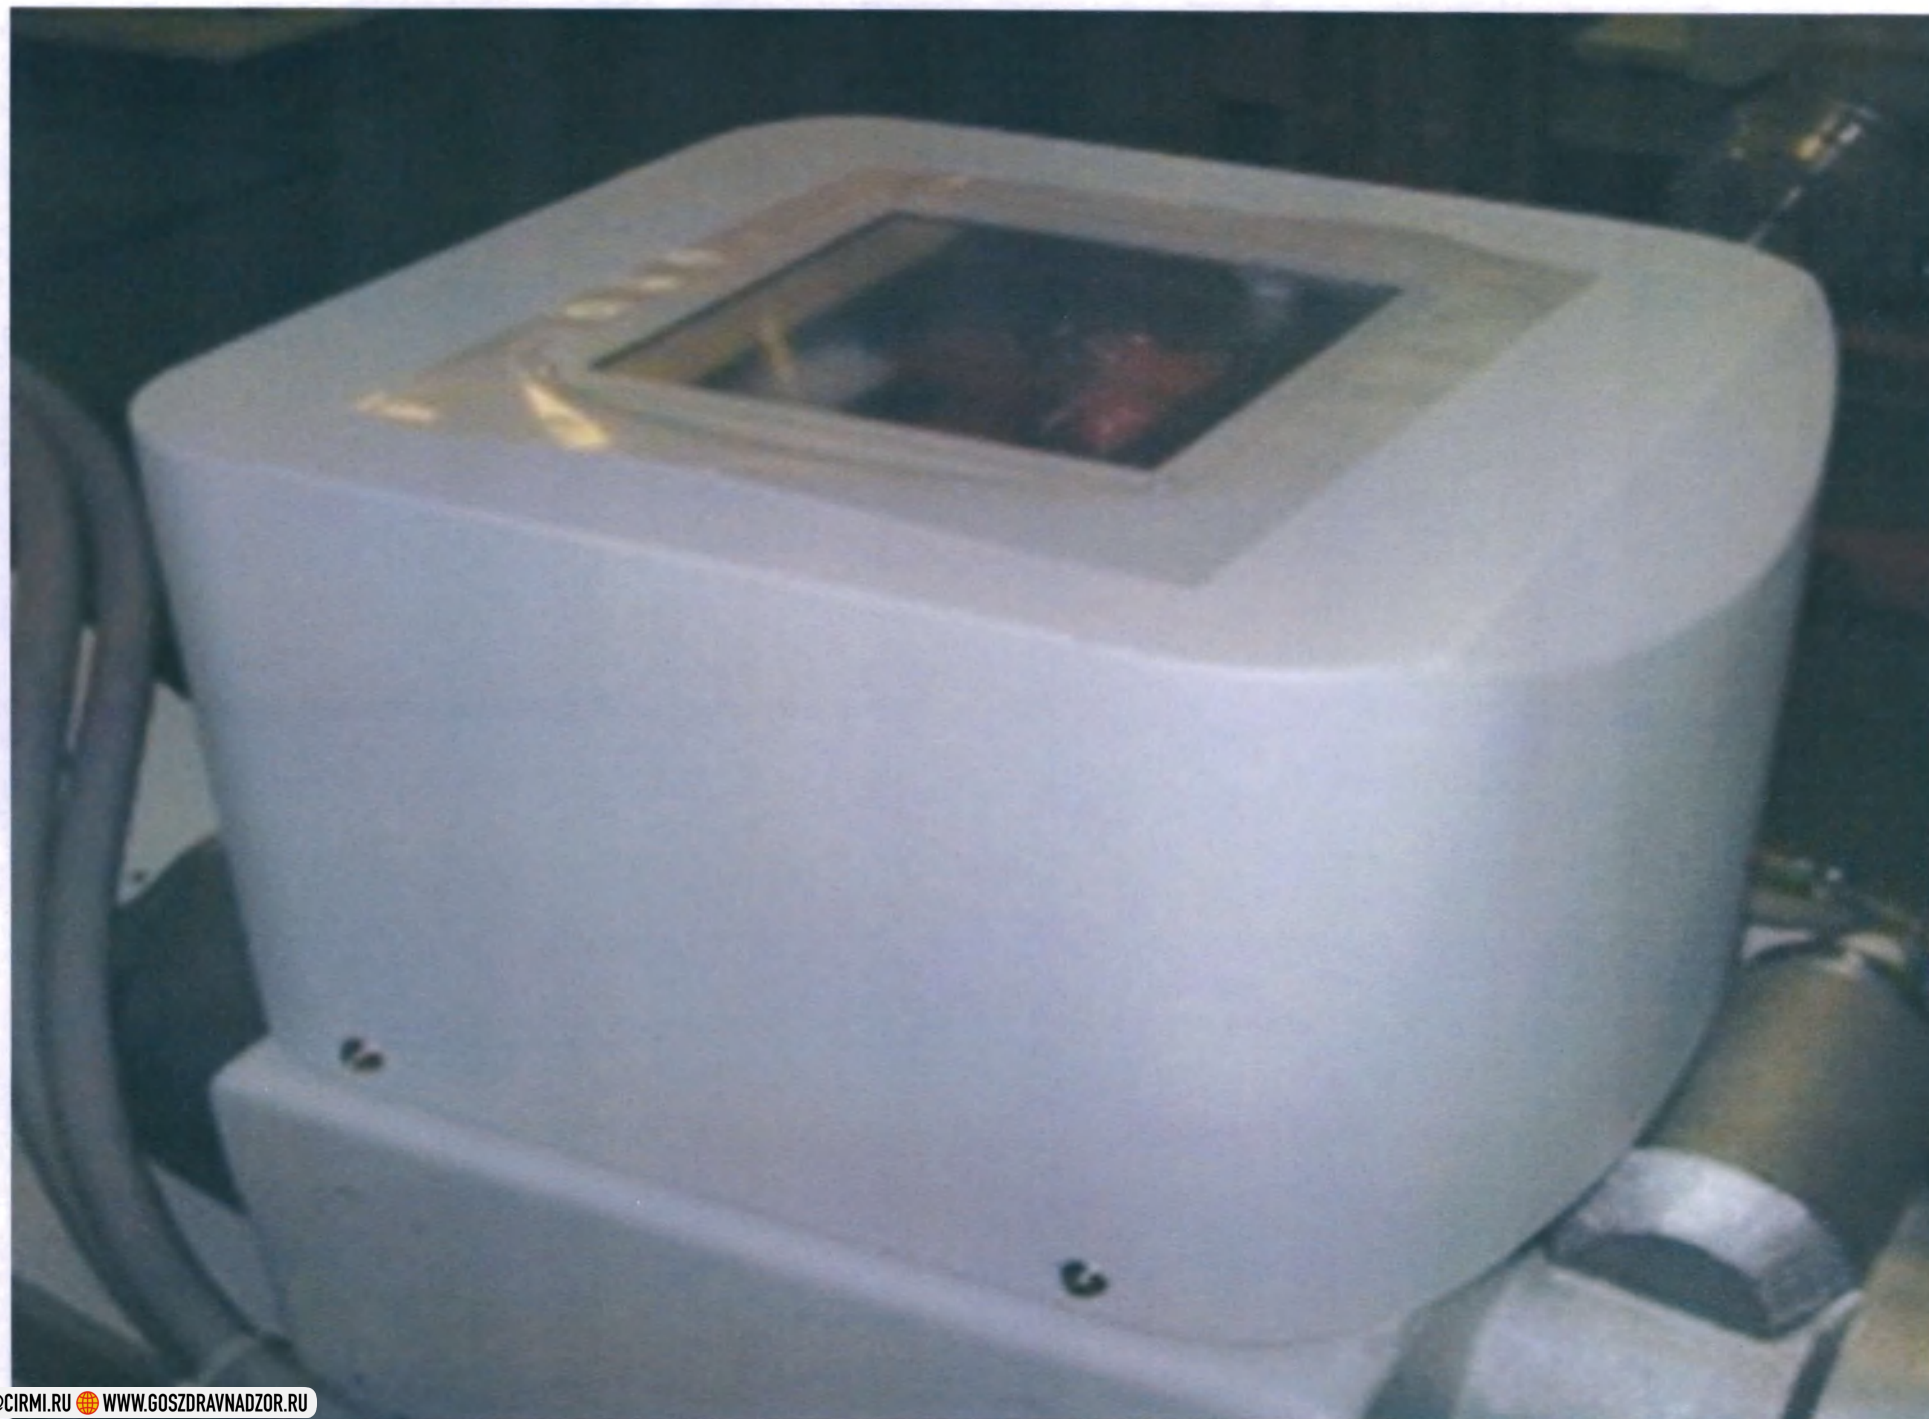


3. Узел рентгеновской трубки модели DSRX-T7345GFS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония)

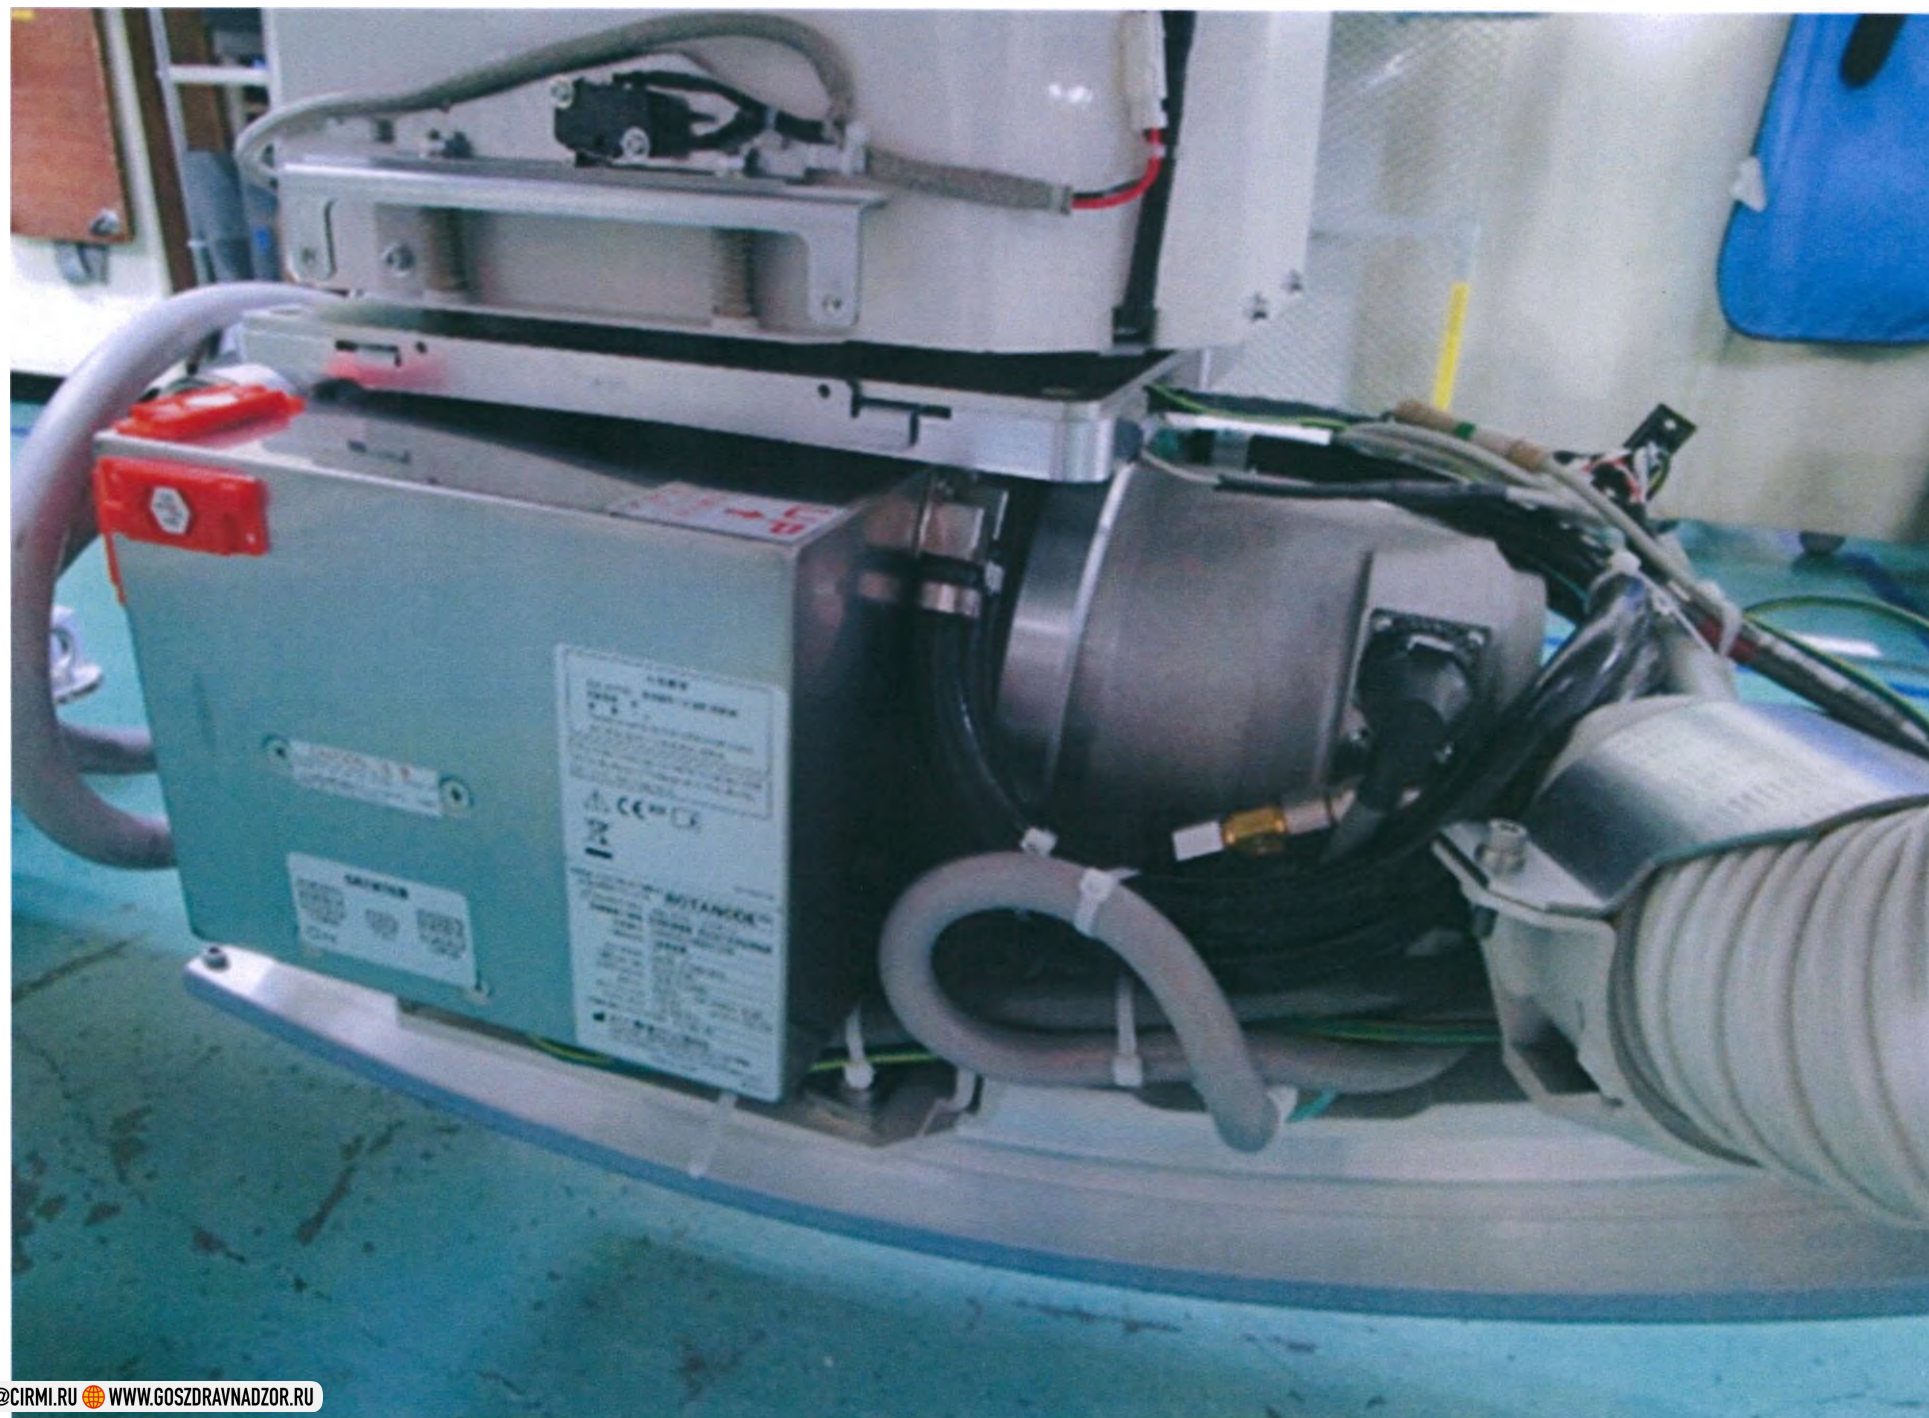


3. Узел рентгеновской трубки модели DSRX-T7445GFS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).

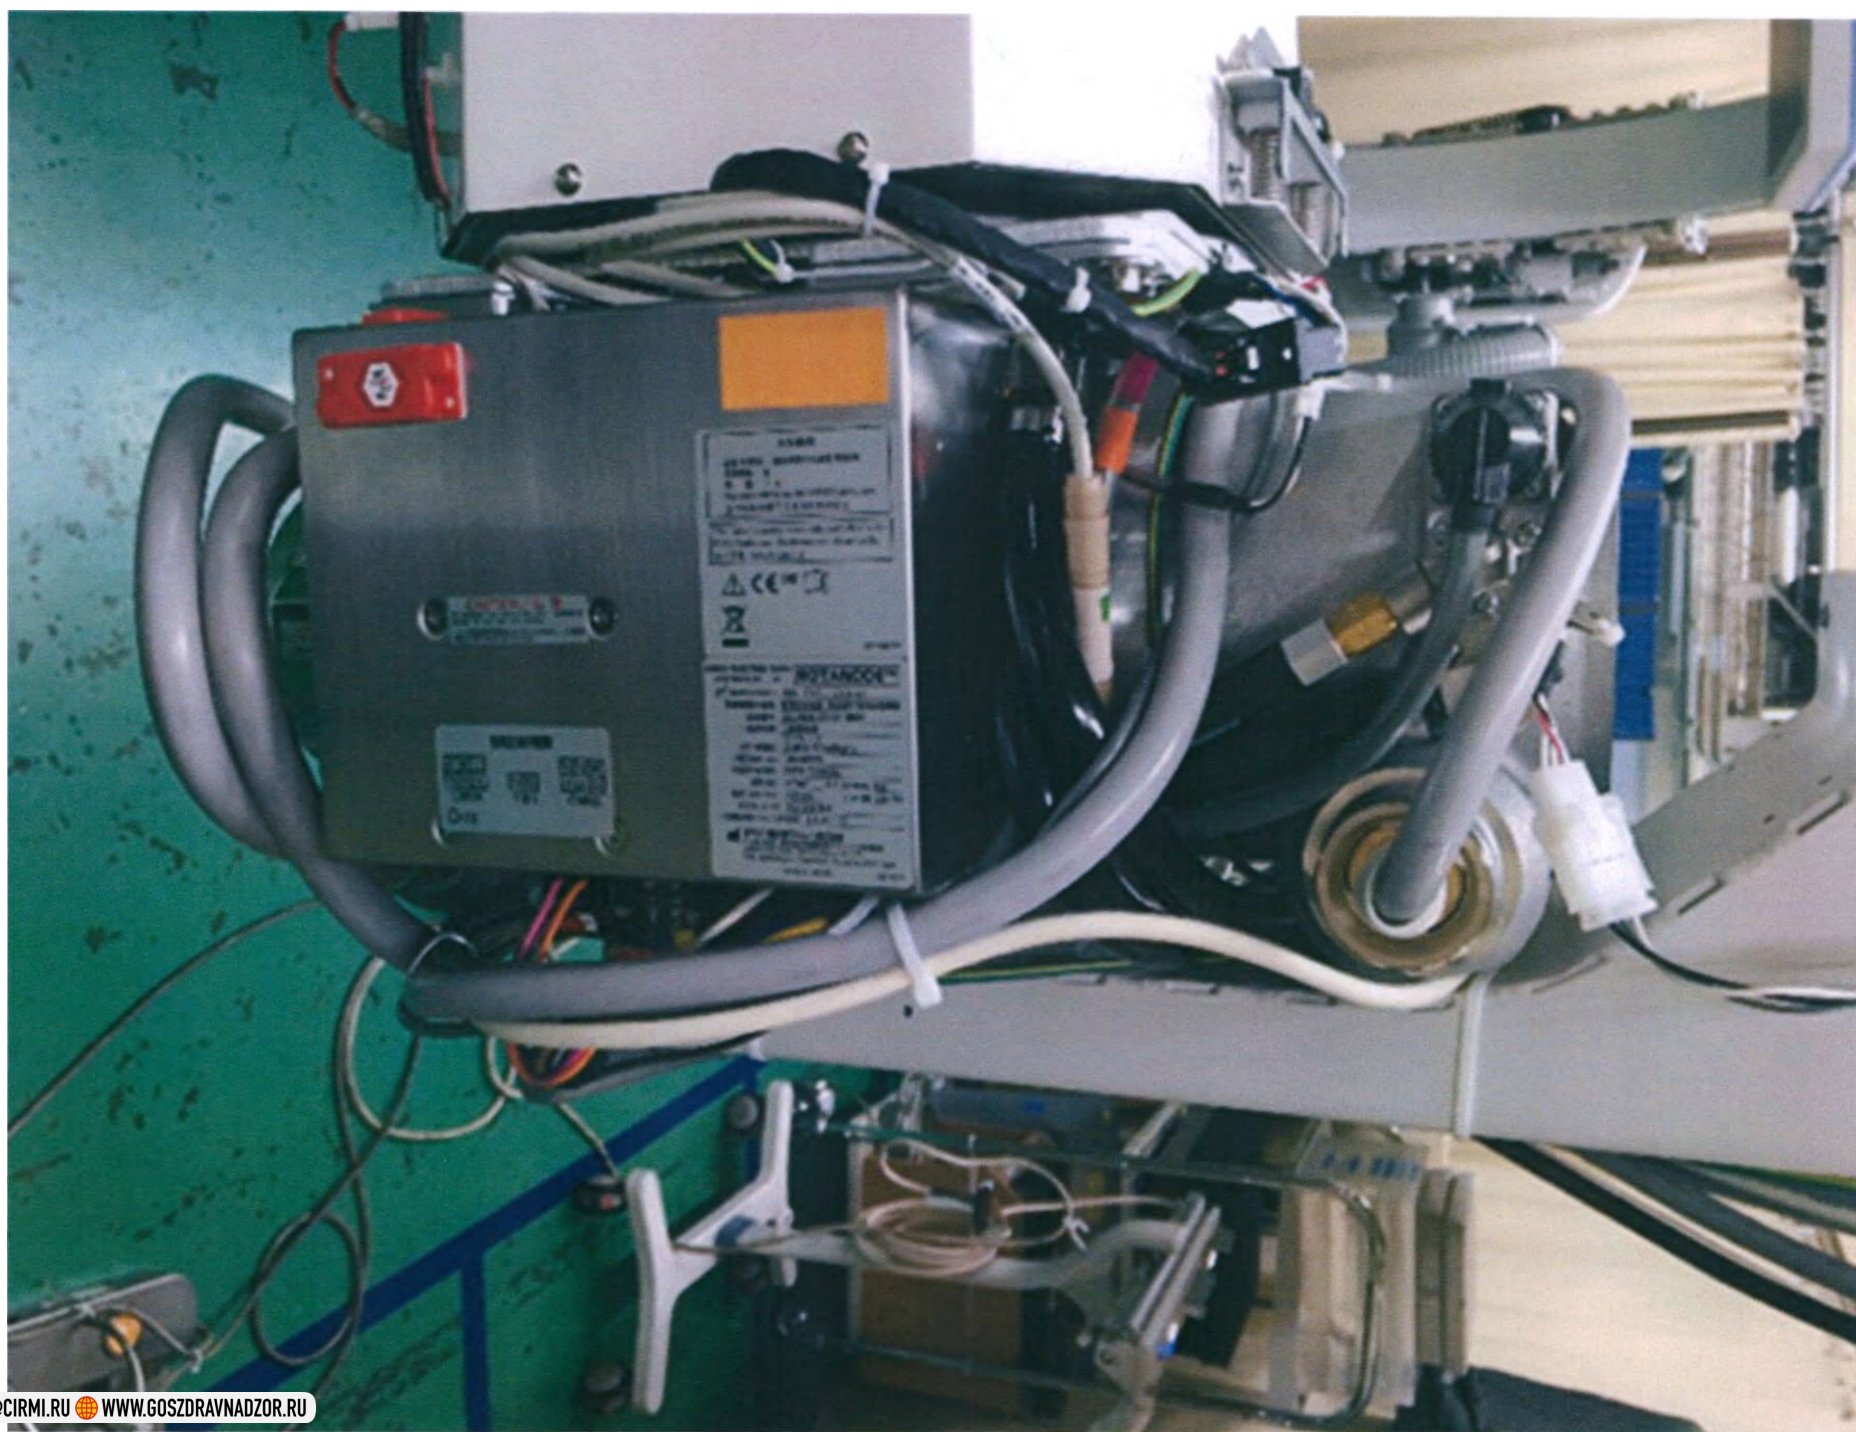

4. Скоростное пусковое устройство с вращающимся анодом (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).

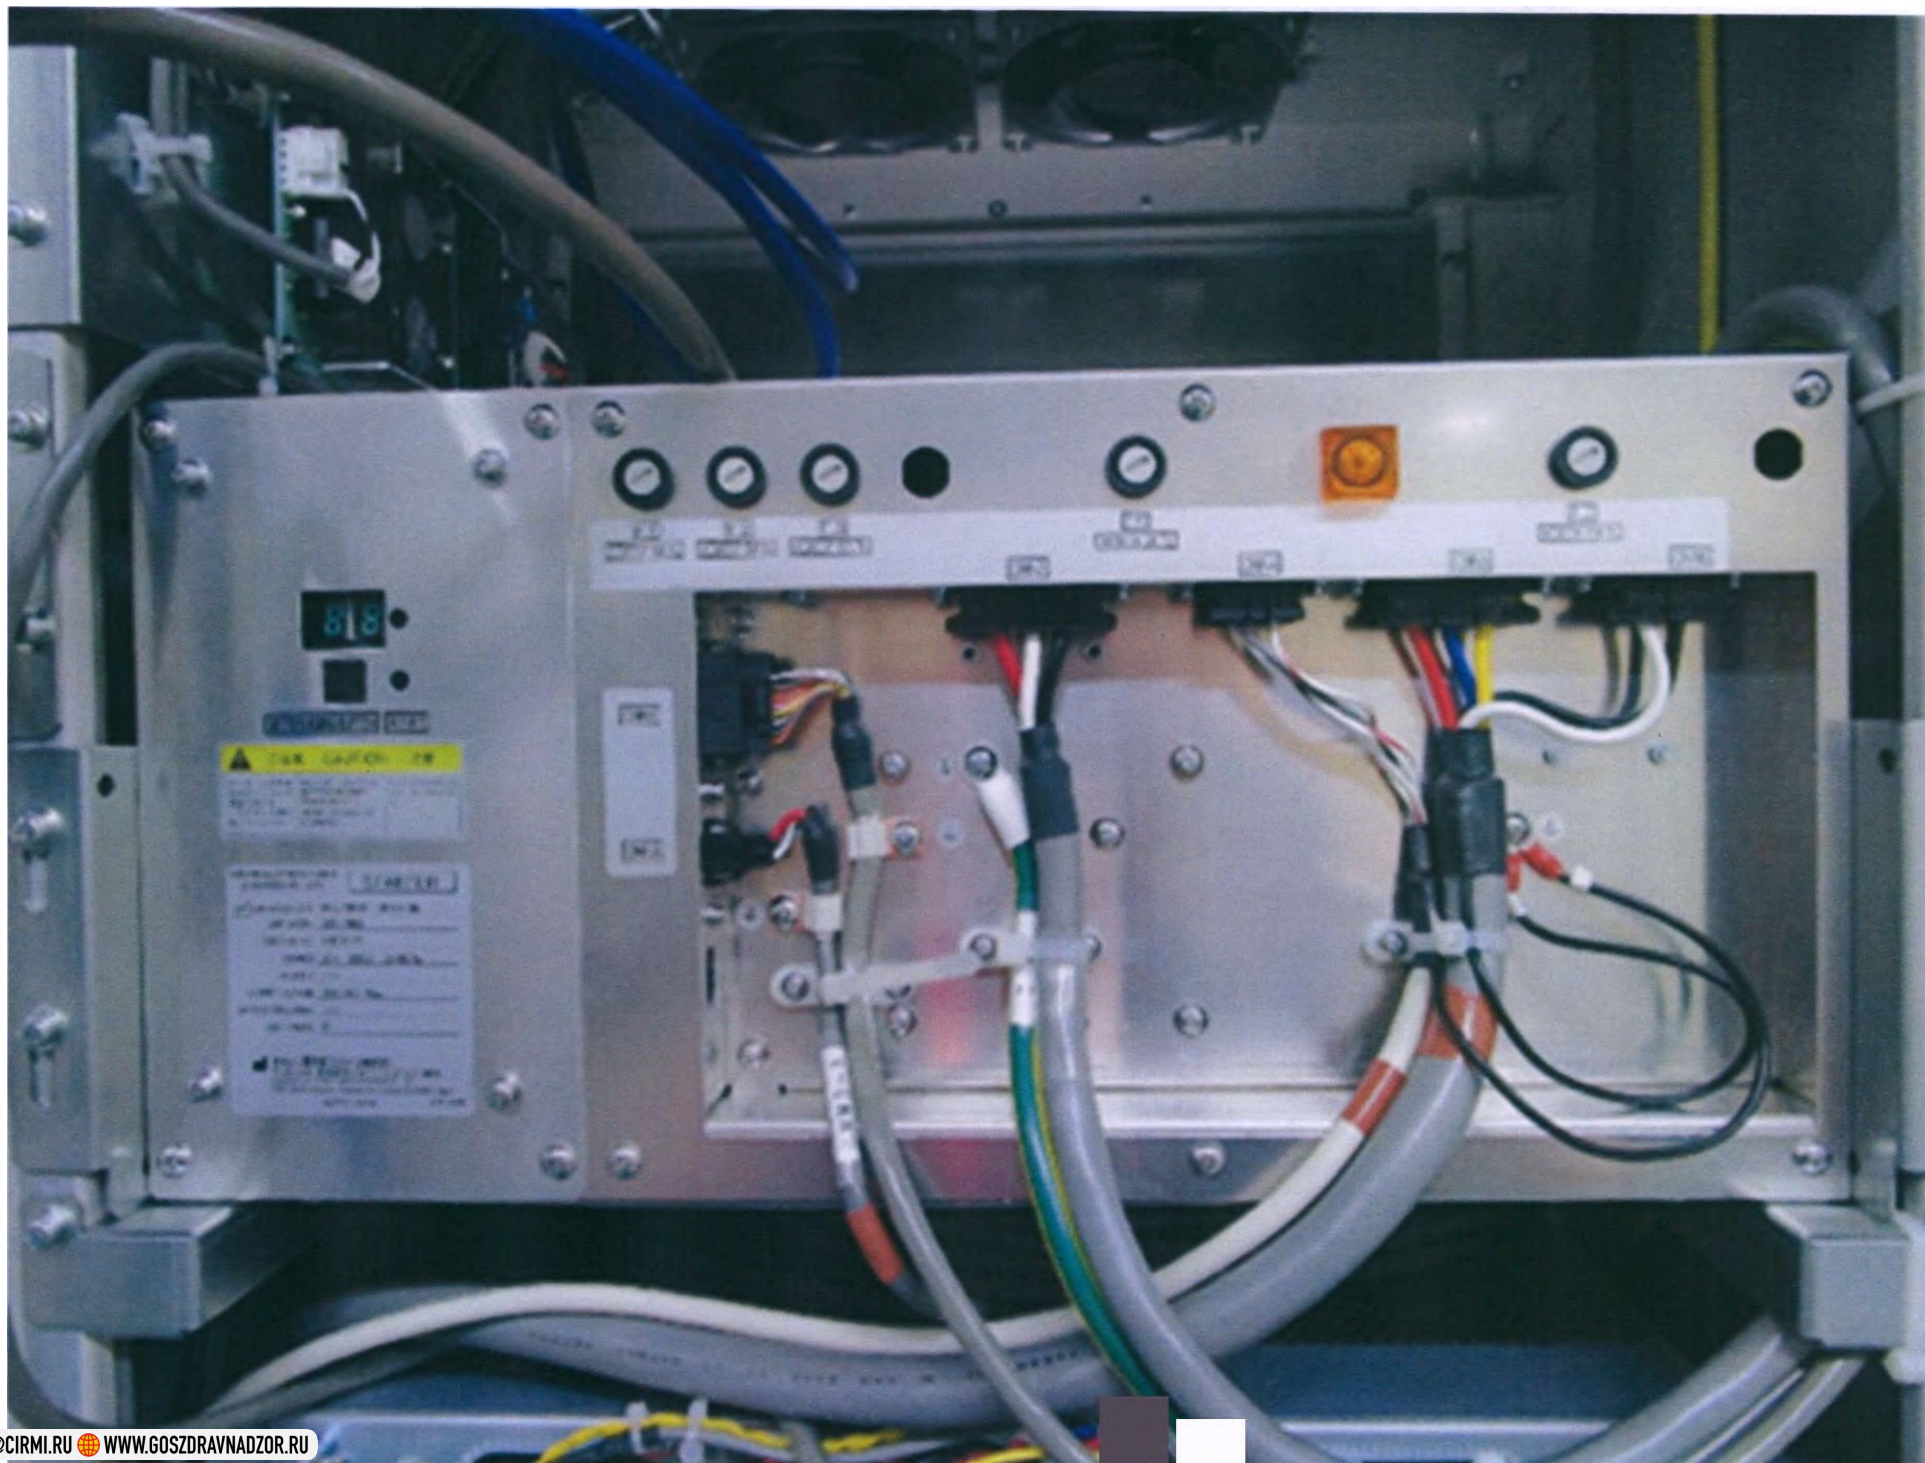

5. Комплект кабелей для рентгеновской трубки.

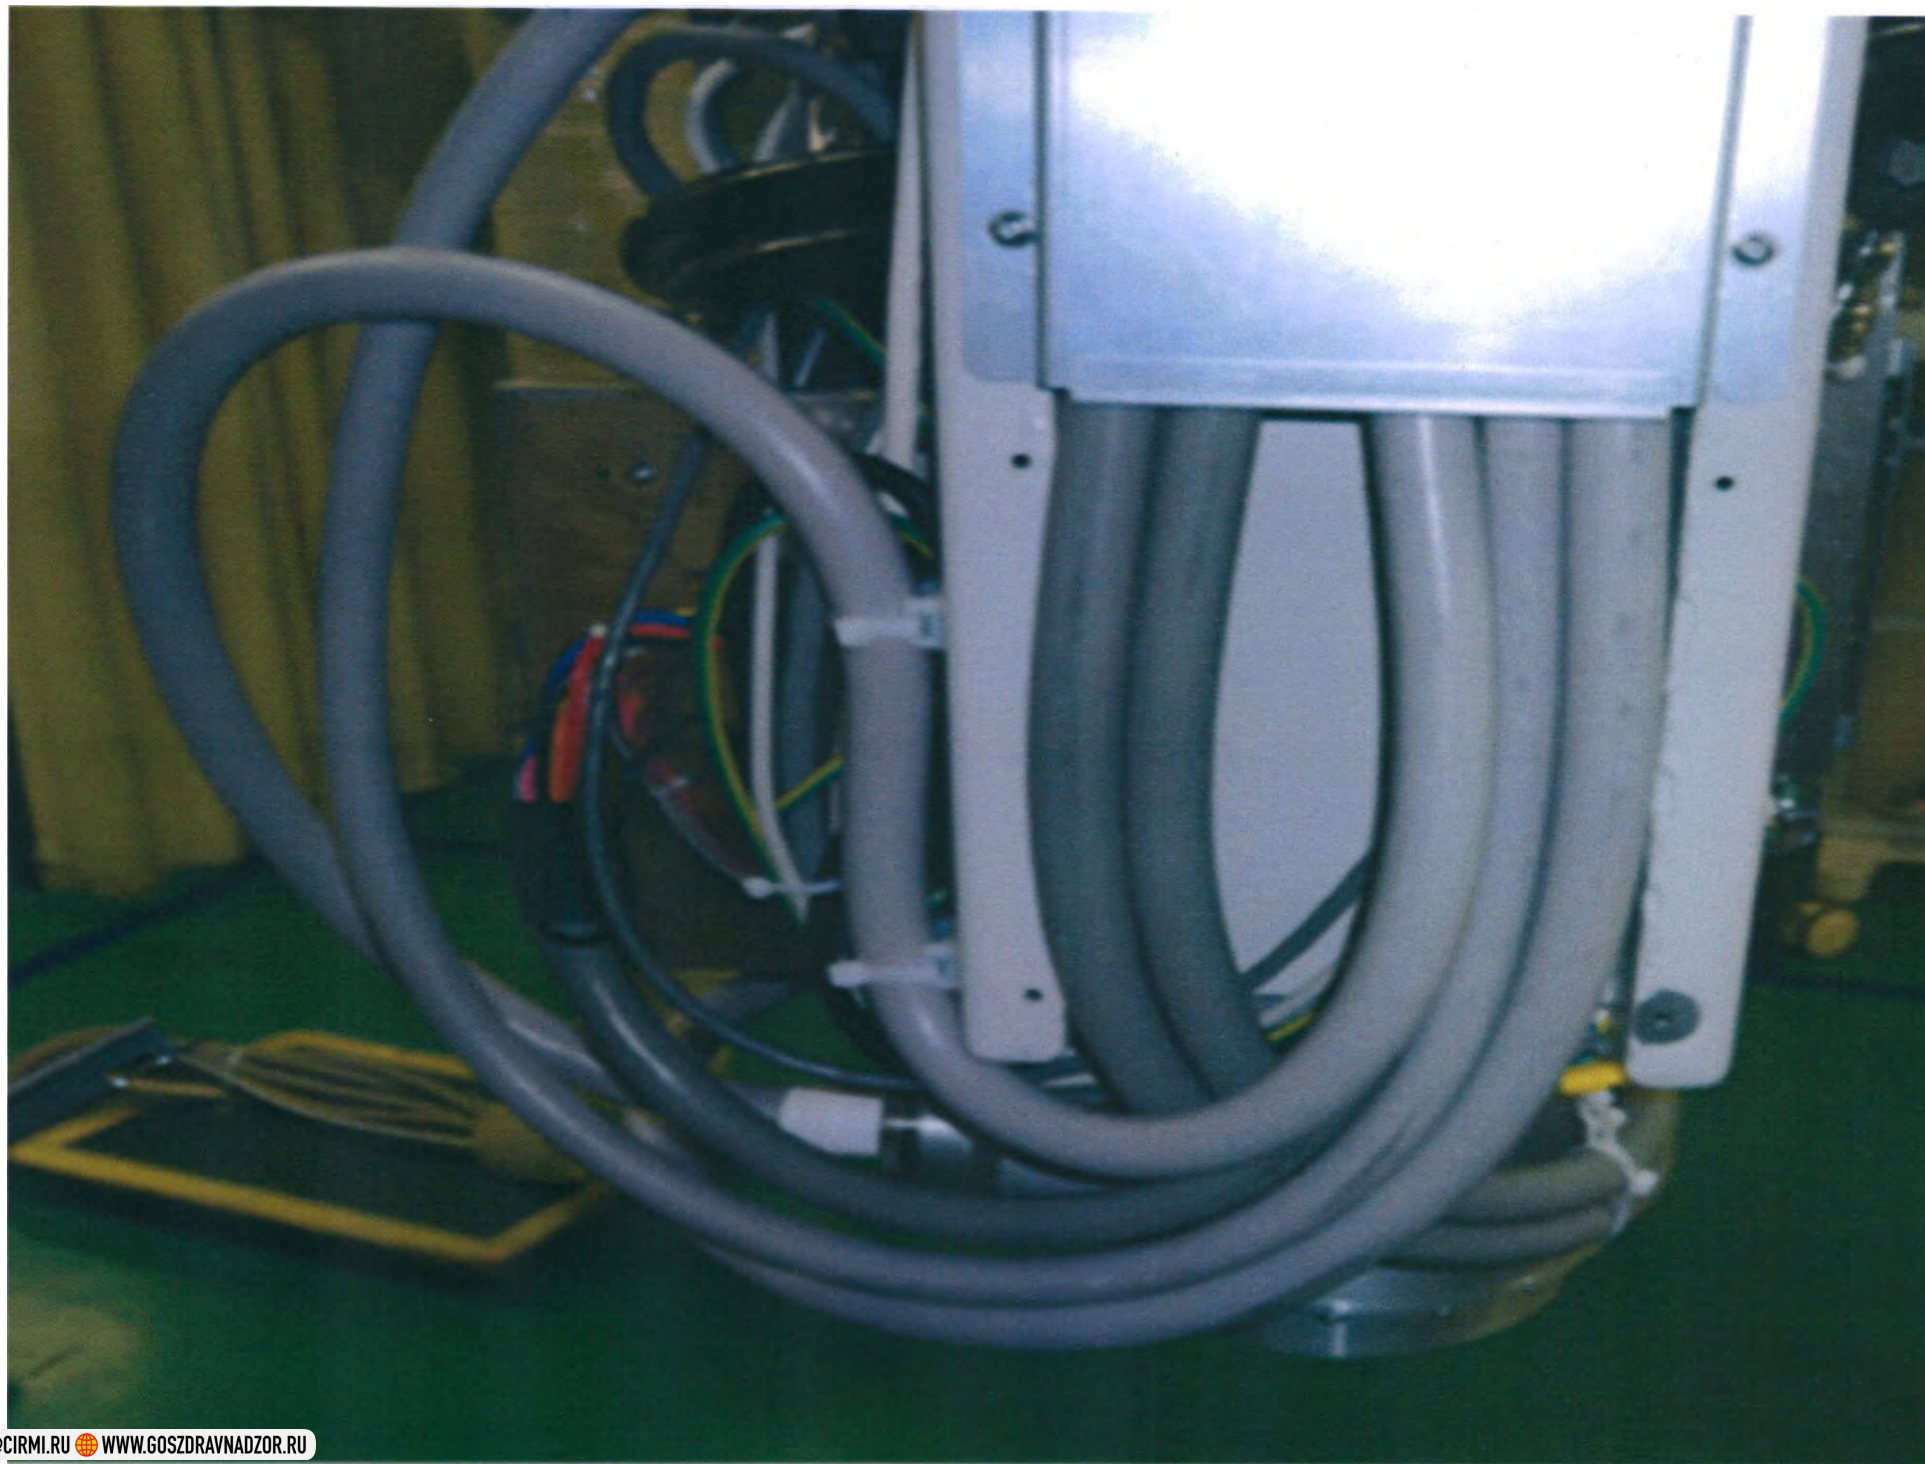

6. Теплообменник с водяным охлаждением (производитель Canon electron tubes & devices, Япония).








9. Рентгеновский плоскопанельный детектор с водяным охлаждением, в вариантах исполнения: - 12-дюймовый FPD (стандартный)



Блок водяного охлаждения



Основной блок 12-дюймового FPD

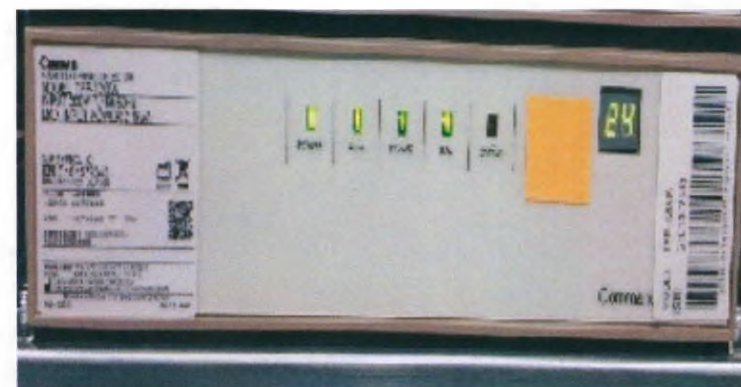


Командный процессор

9. Рентгеновский плоскопанельный детектор с водяным охлаждением, в вариантах исполнения: - 12-дюймовый FPD (высокой четкости).



Блок водяного охлаждения

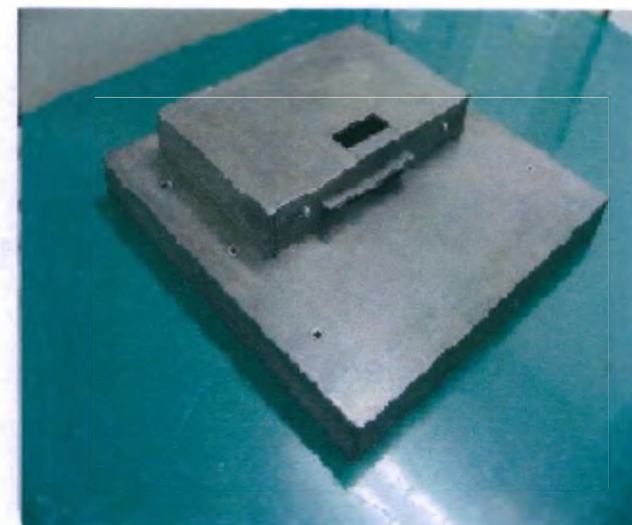

Основной блок 12-дюймового FPD




Командный процессор

9. Рентгеновский плоскопанельный детектор с водяным охлаждением, в вариантах исполнения: - FPD 12 x 16 дюймов.



Блок водяного охлаждения

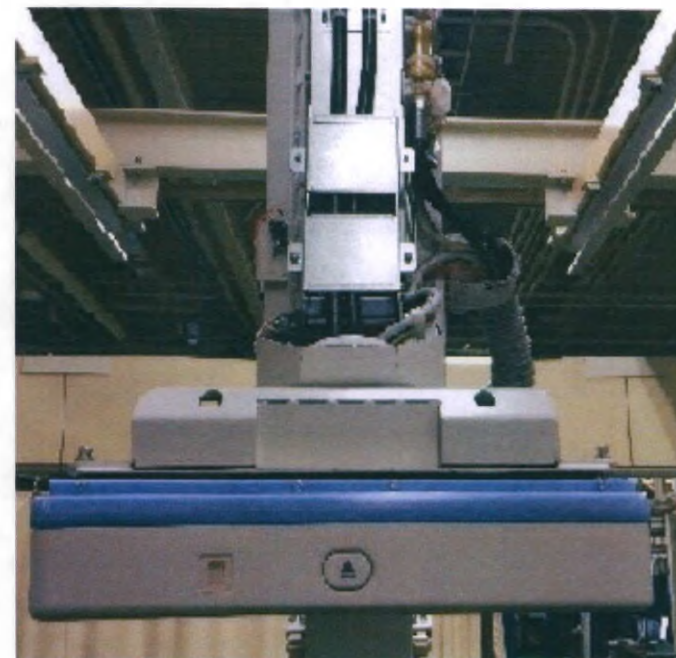

Основной блок FPD 12x16 дюймов




Командный процессор







Установлены внутри
шкафа управления
CAS-880A

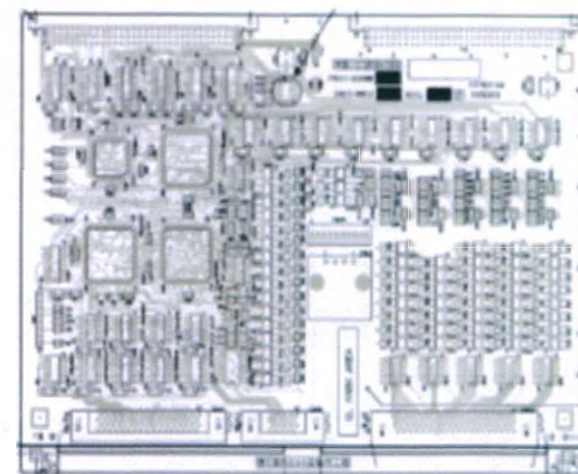

Электронная плата Hyper IO pcb

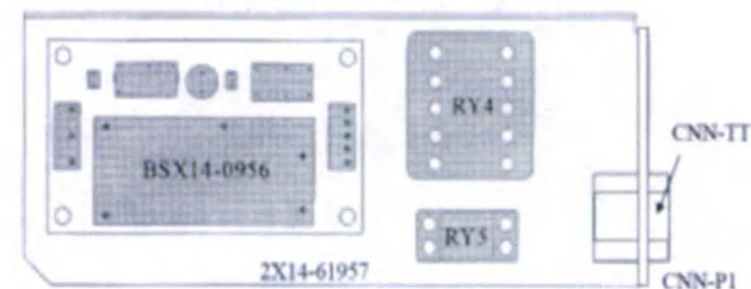

Интерфейсный блок

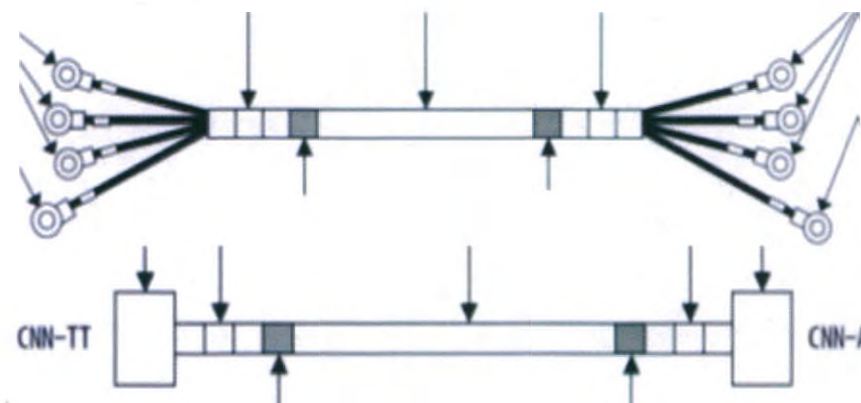


Интерфейсные кабели

12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: - основная часть стола для катетеризации;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель CAT-850B, в составе: - стандартная накладка для деки стола;

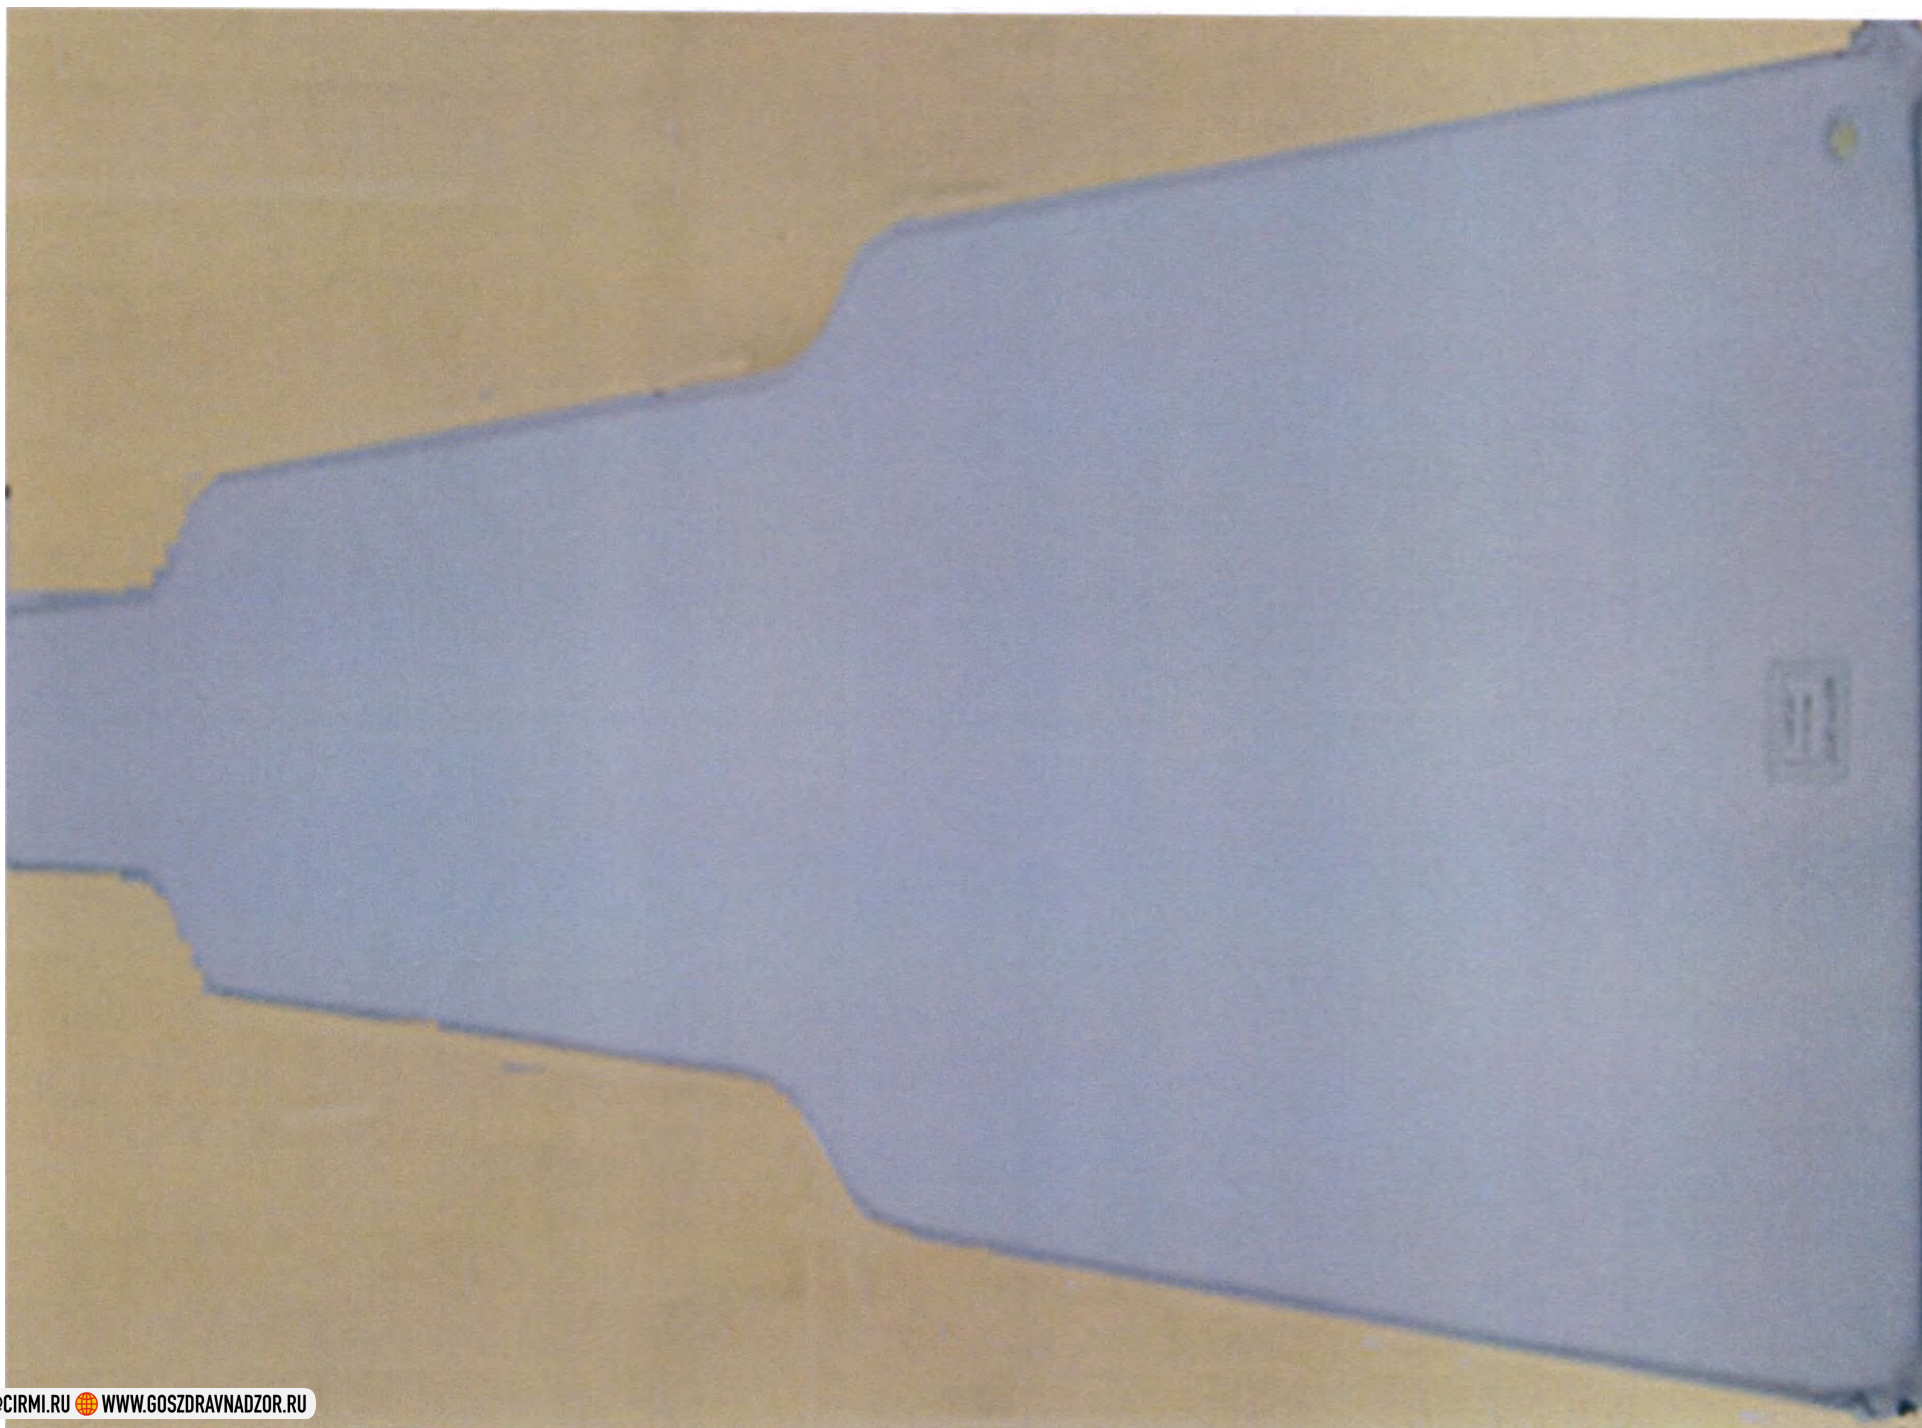


12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: ; - стойка для капельной инфузии;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: - опора для рук;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель CAT-850B, в составе: - подлокотник.

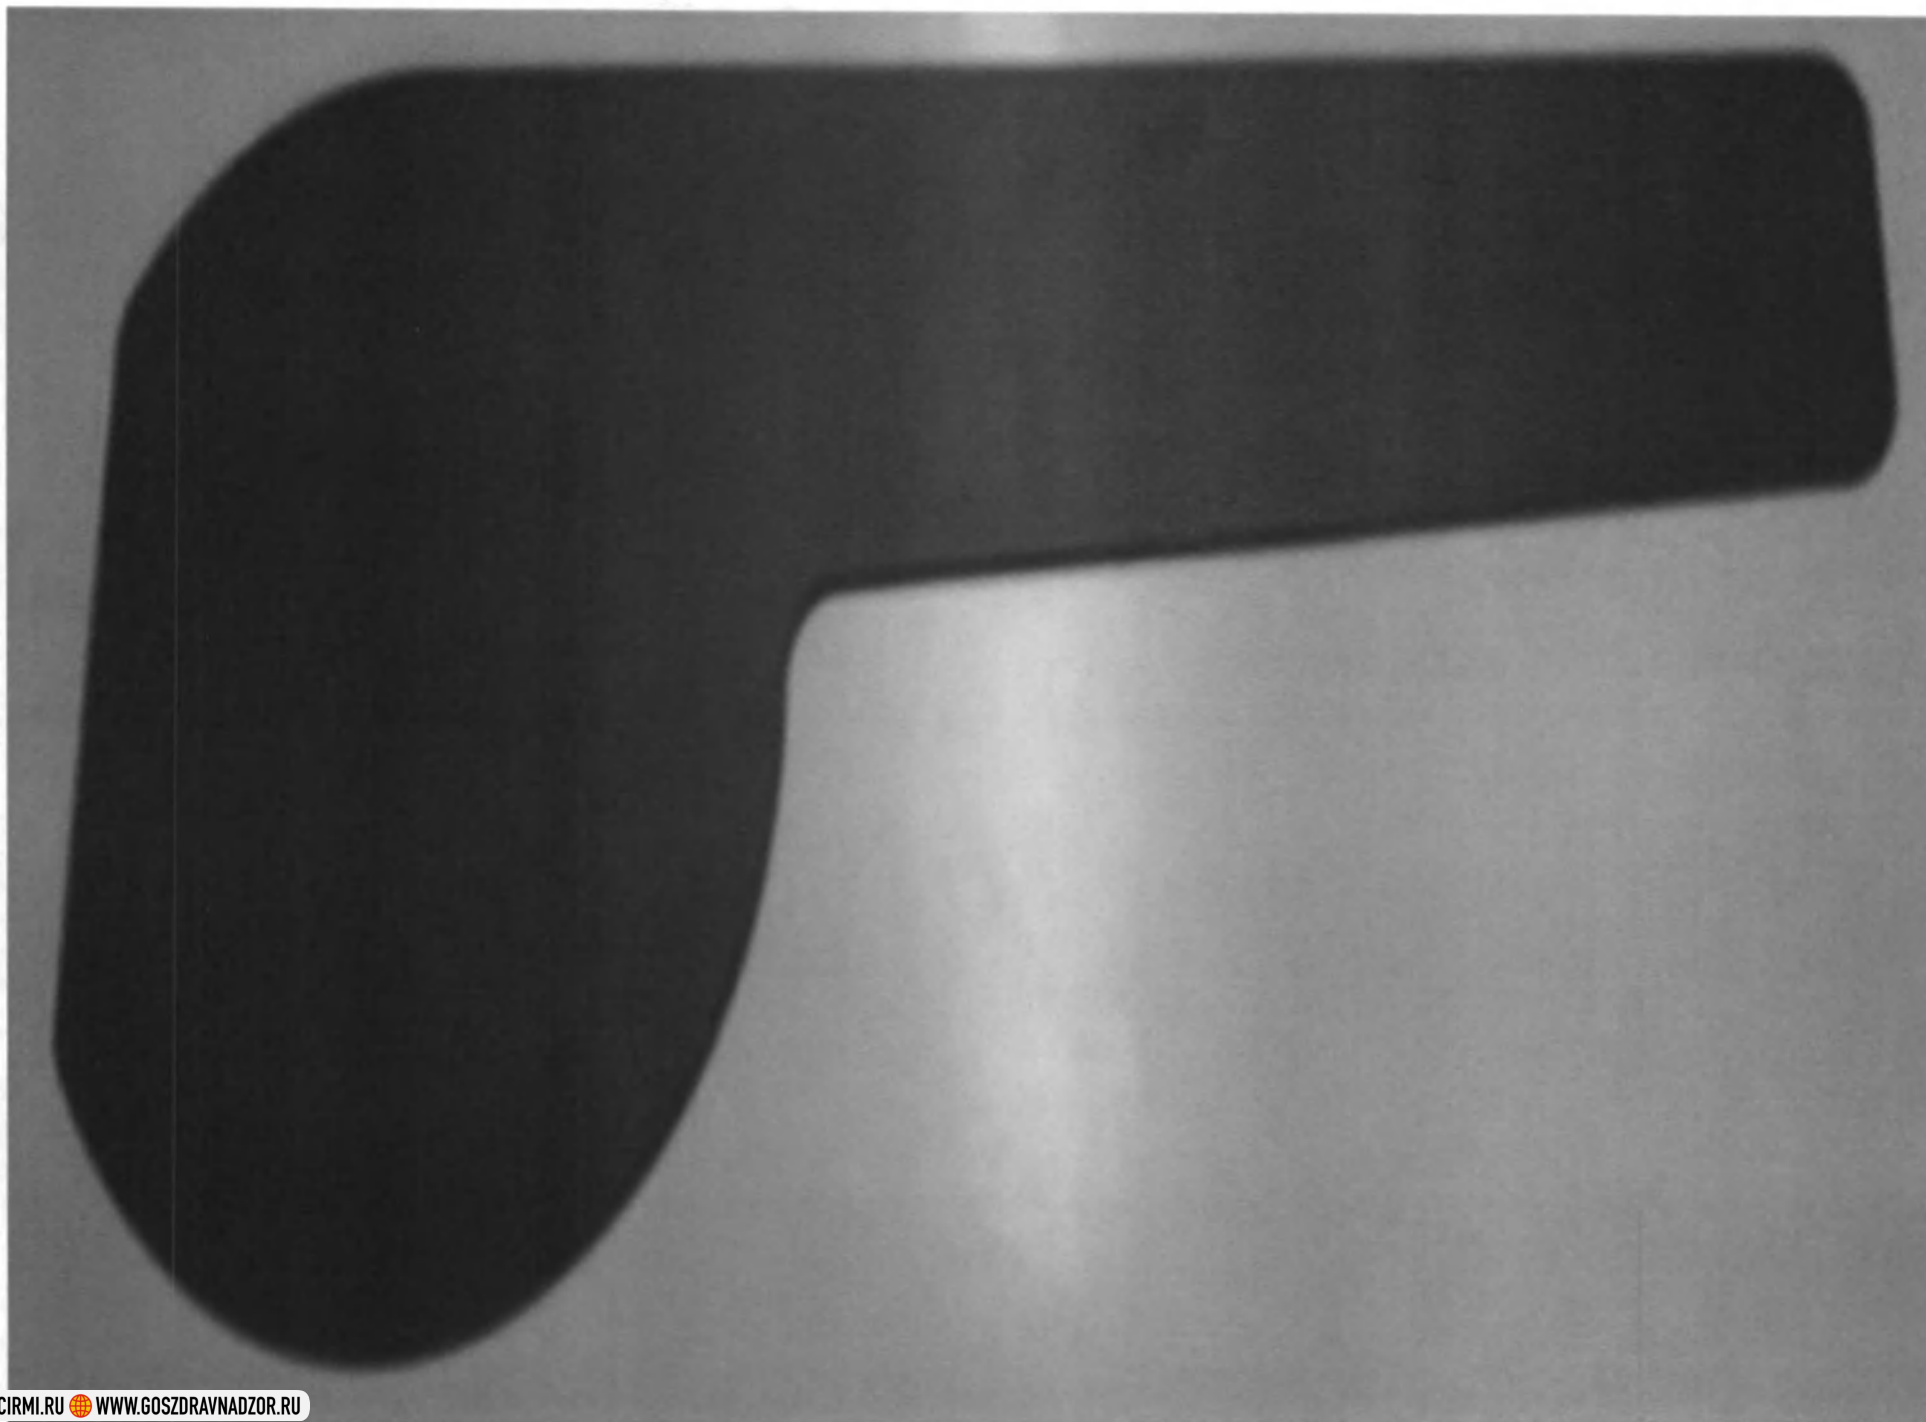

12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель CAT-880B, в составе: - основная часть стола для катетеризации; .



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - пульт управления столом;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - стойка для капельной инфузии;



12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - стандартная накладка для деки стола;




12. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - ремень для иммобилизации пациента - не более 2-х штук.



13. Ножной переключатель (в кабинете сканирования).

204




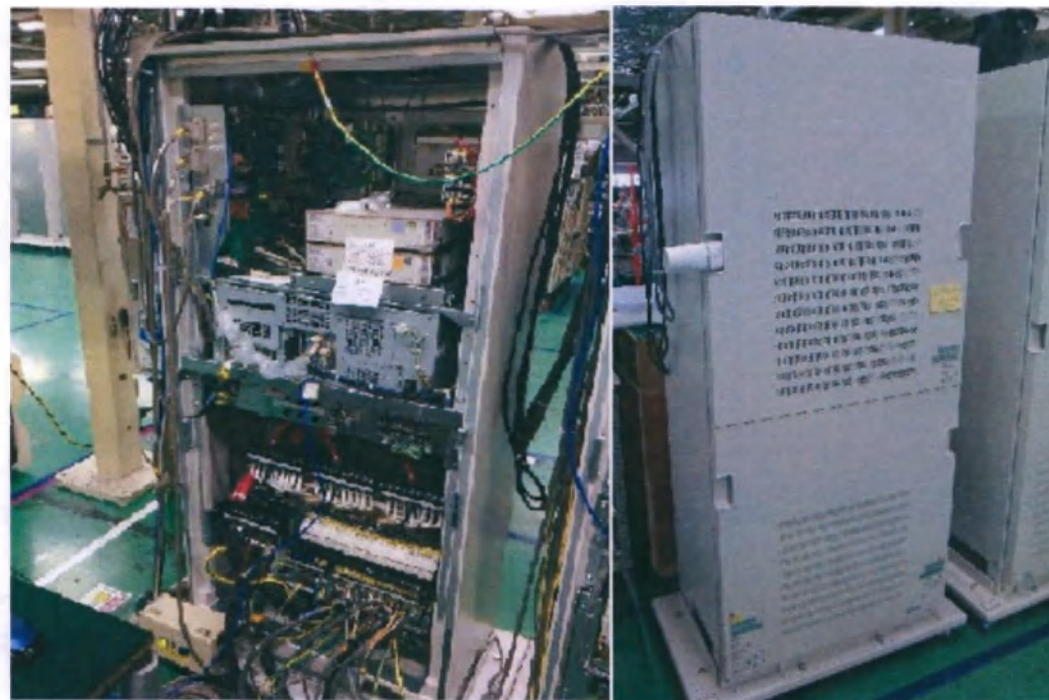

Системный шкаф



Компьютер
консоли системы

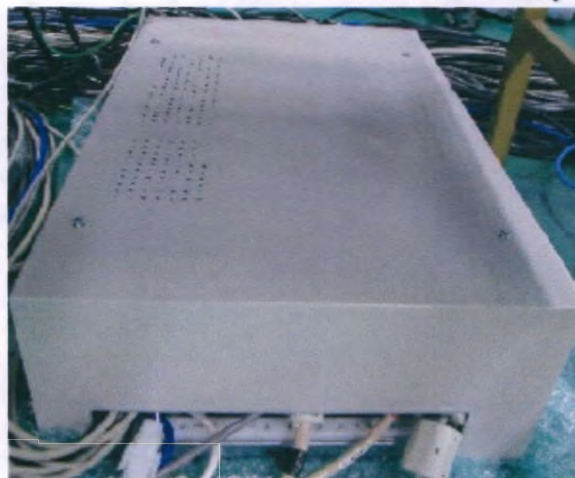

Блок управления



Программное обеспечение
основное

15. Консоль системы, в составе: - комплект клавиатуры;



15. Консоль системы, в составе: - комплект клавиатуры;

201



15. Консоль системы, в составе: - монитор системы; - блок включения электропитания.

200




16. Ножной переключатель для рентгенографии в кабинете управления.









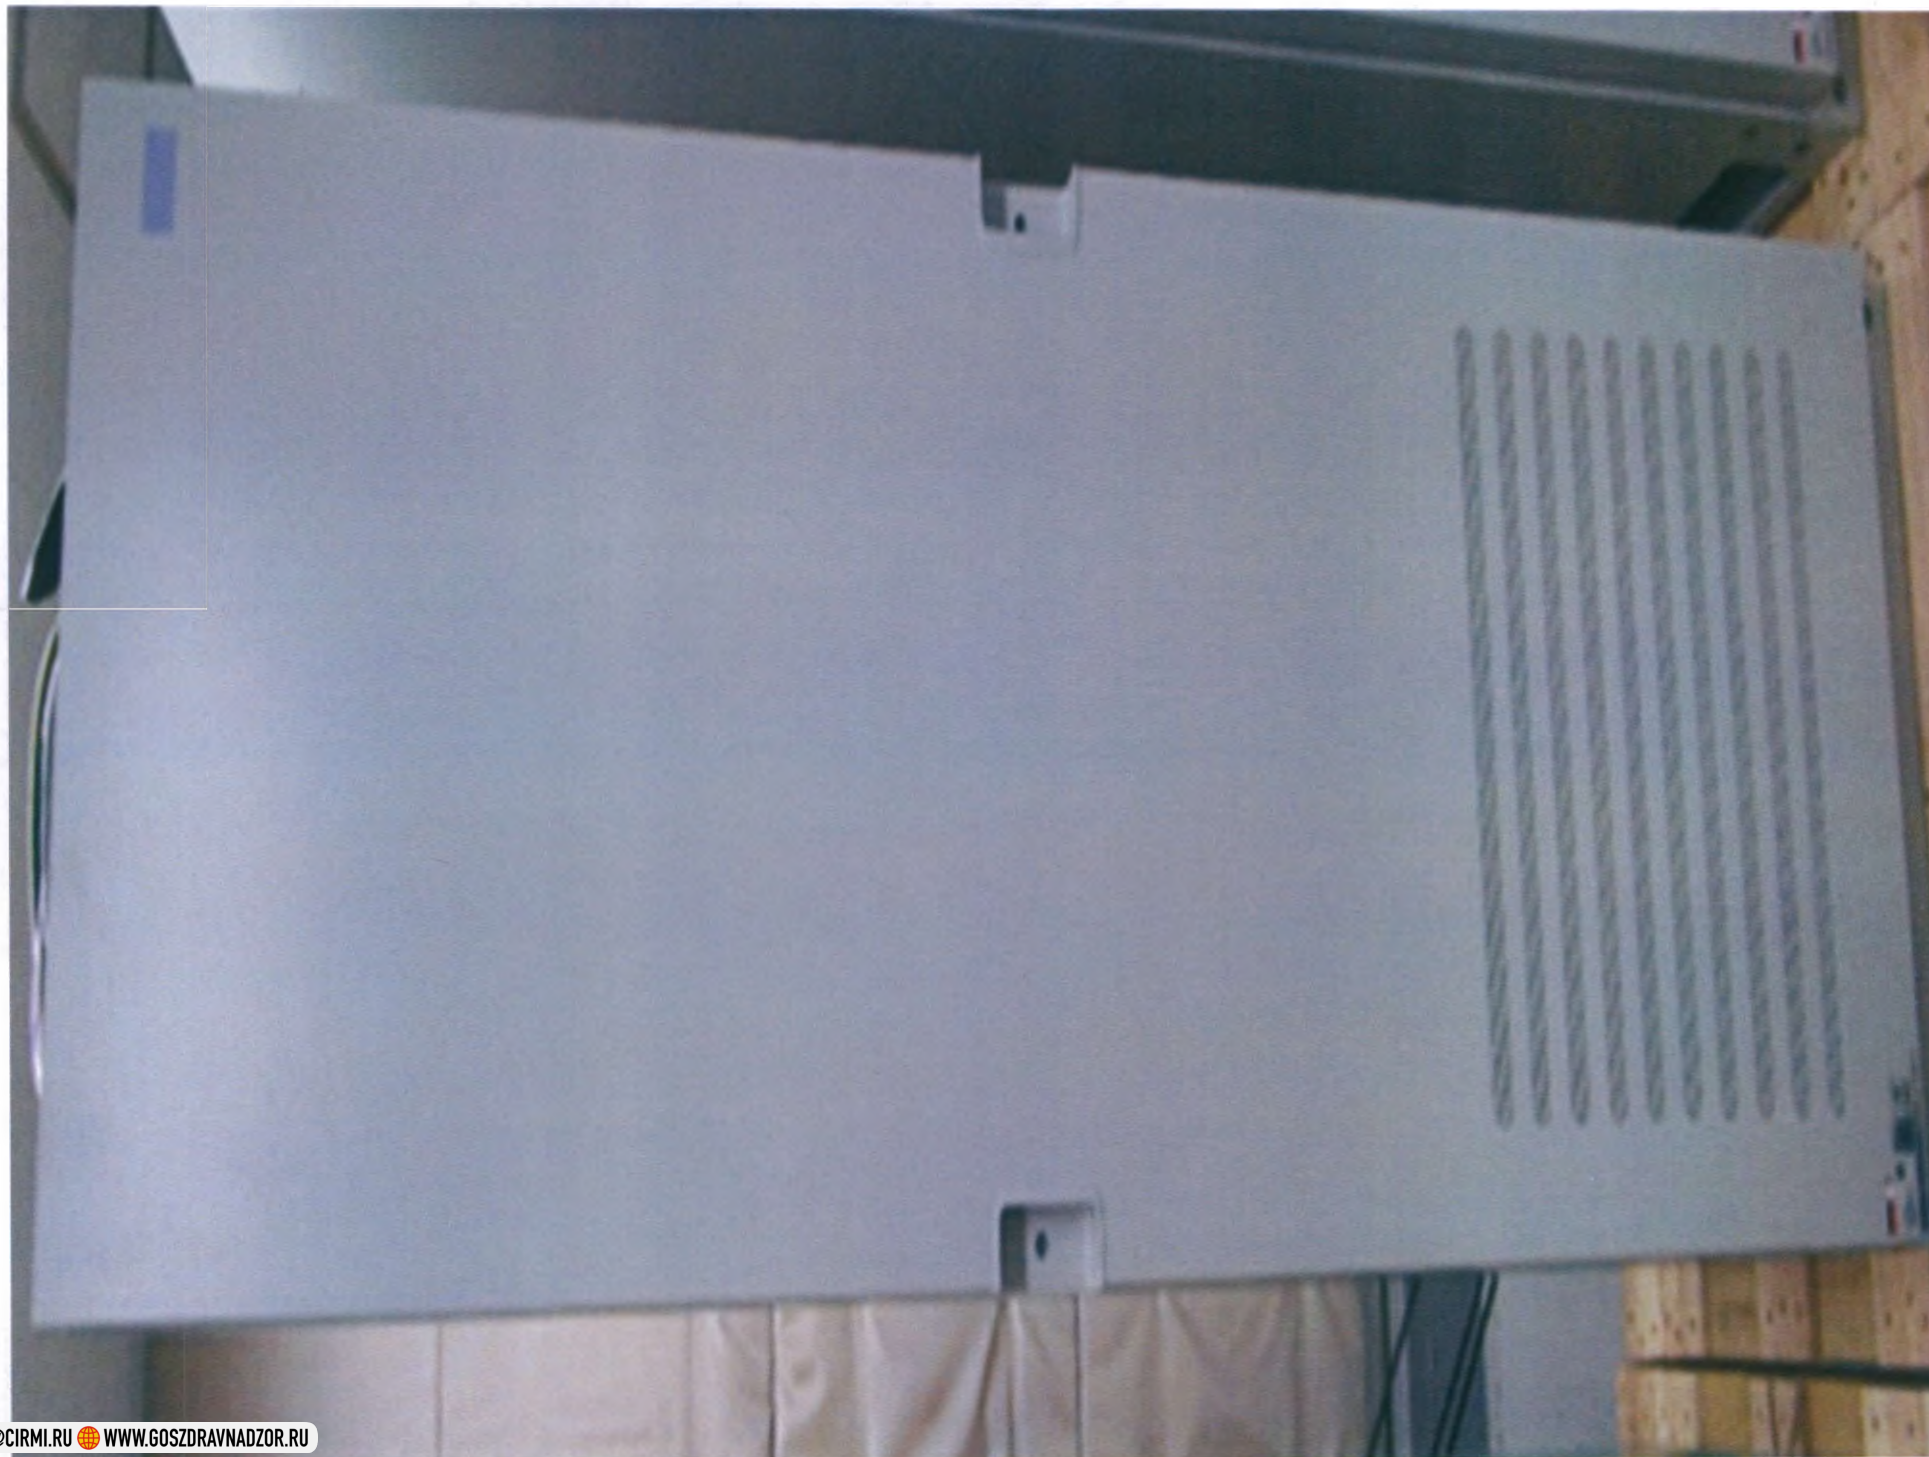


20. Подвесное устройство для мониторов.

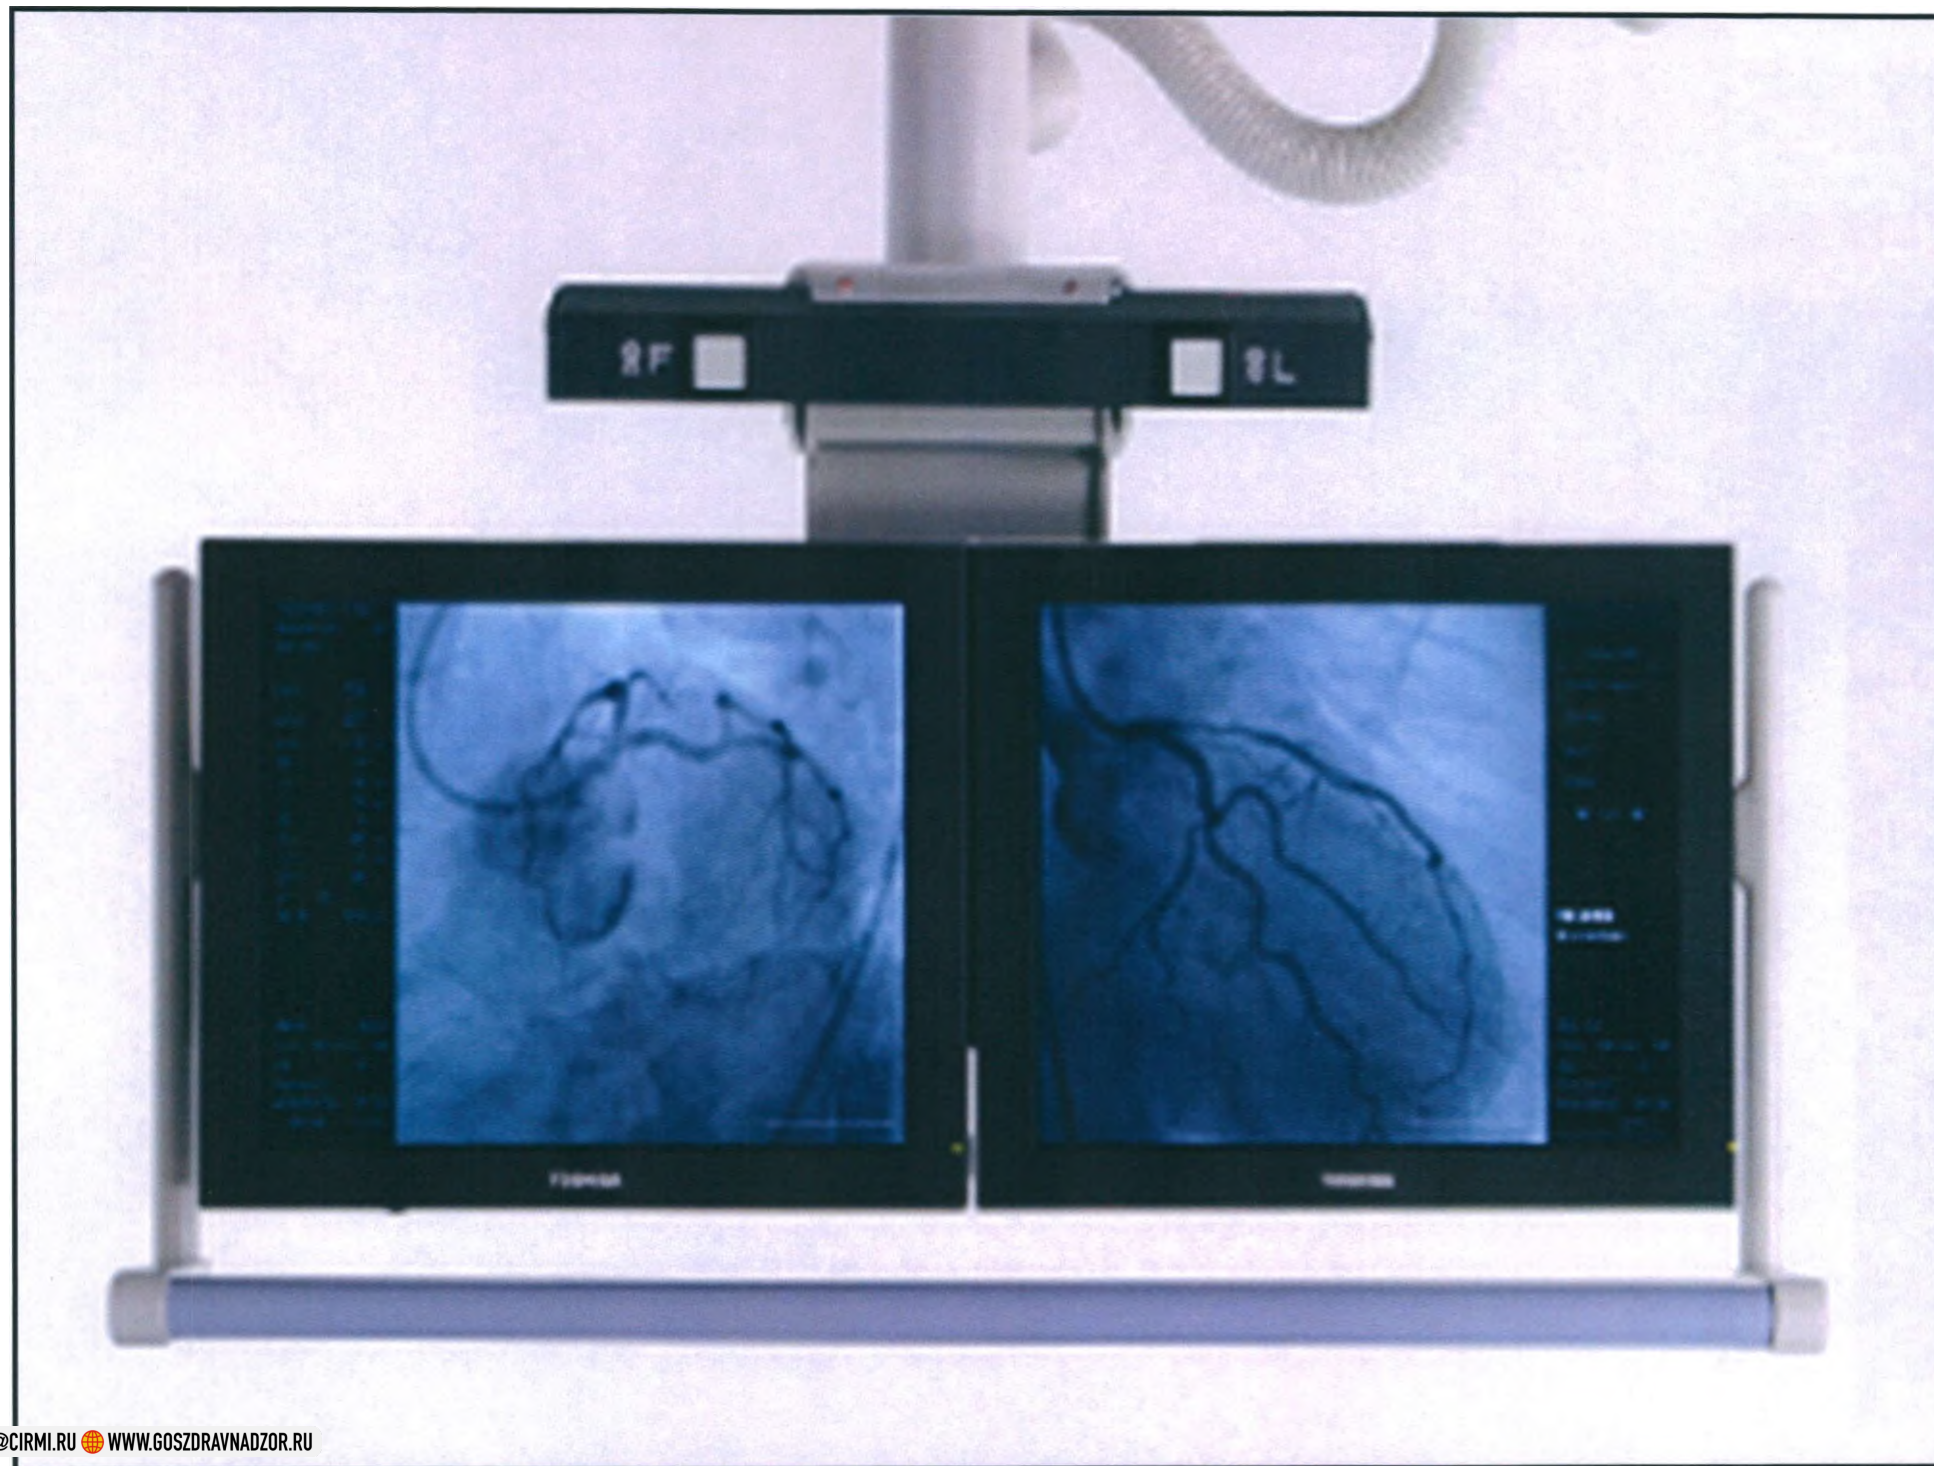


20. Подвесное устройство для мониторов.

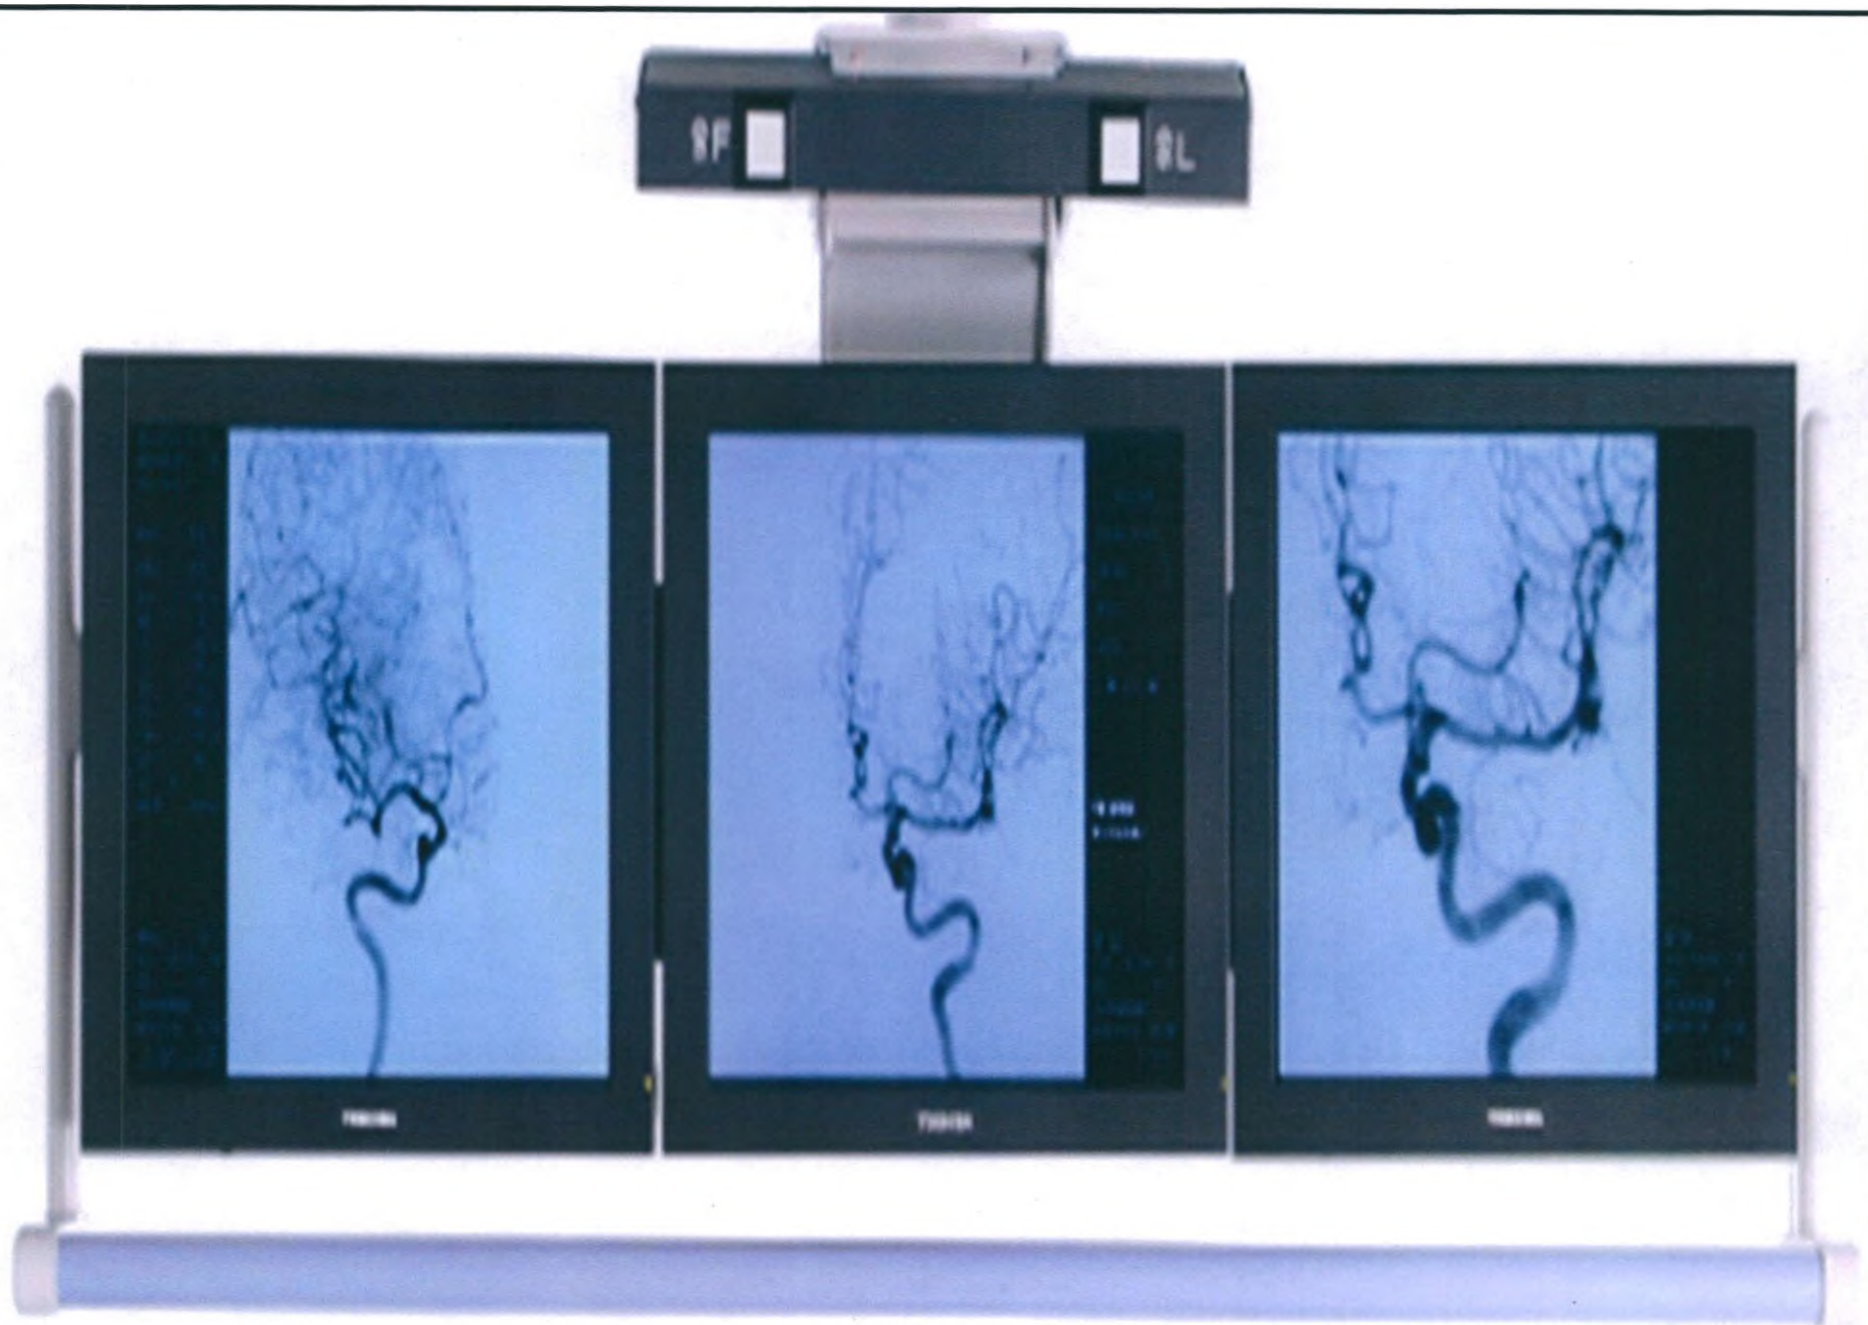


20. Подвесное устройство для мониторов.

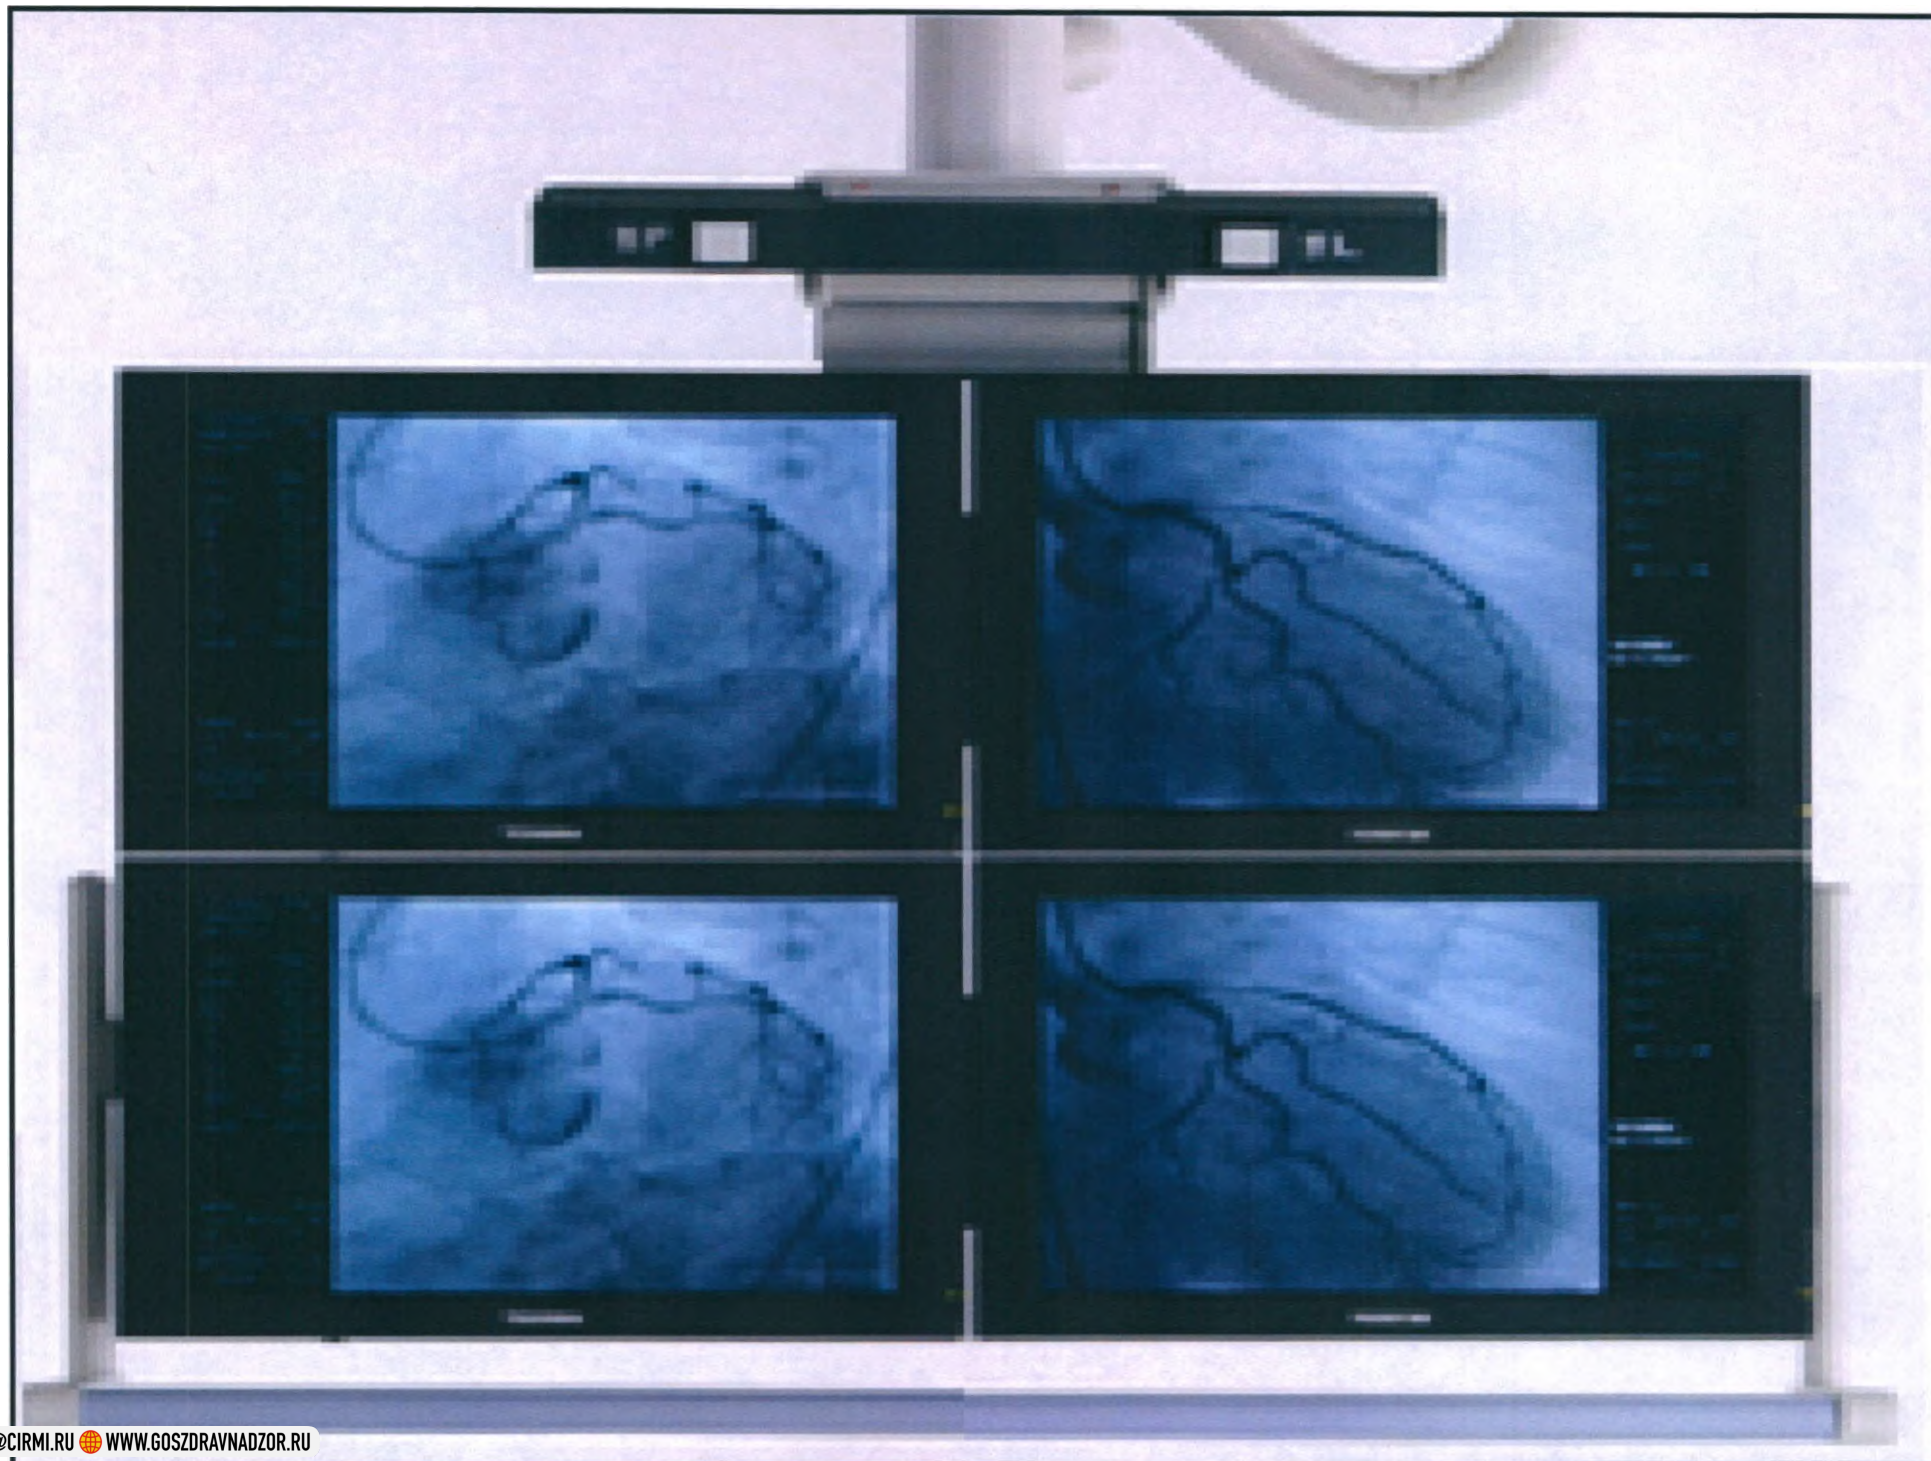


20. Подвесное устройство для мониторов.

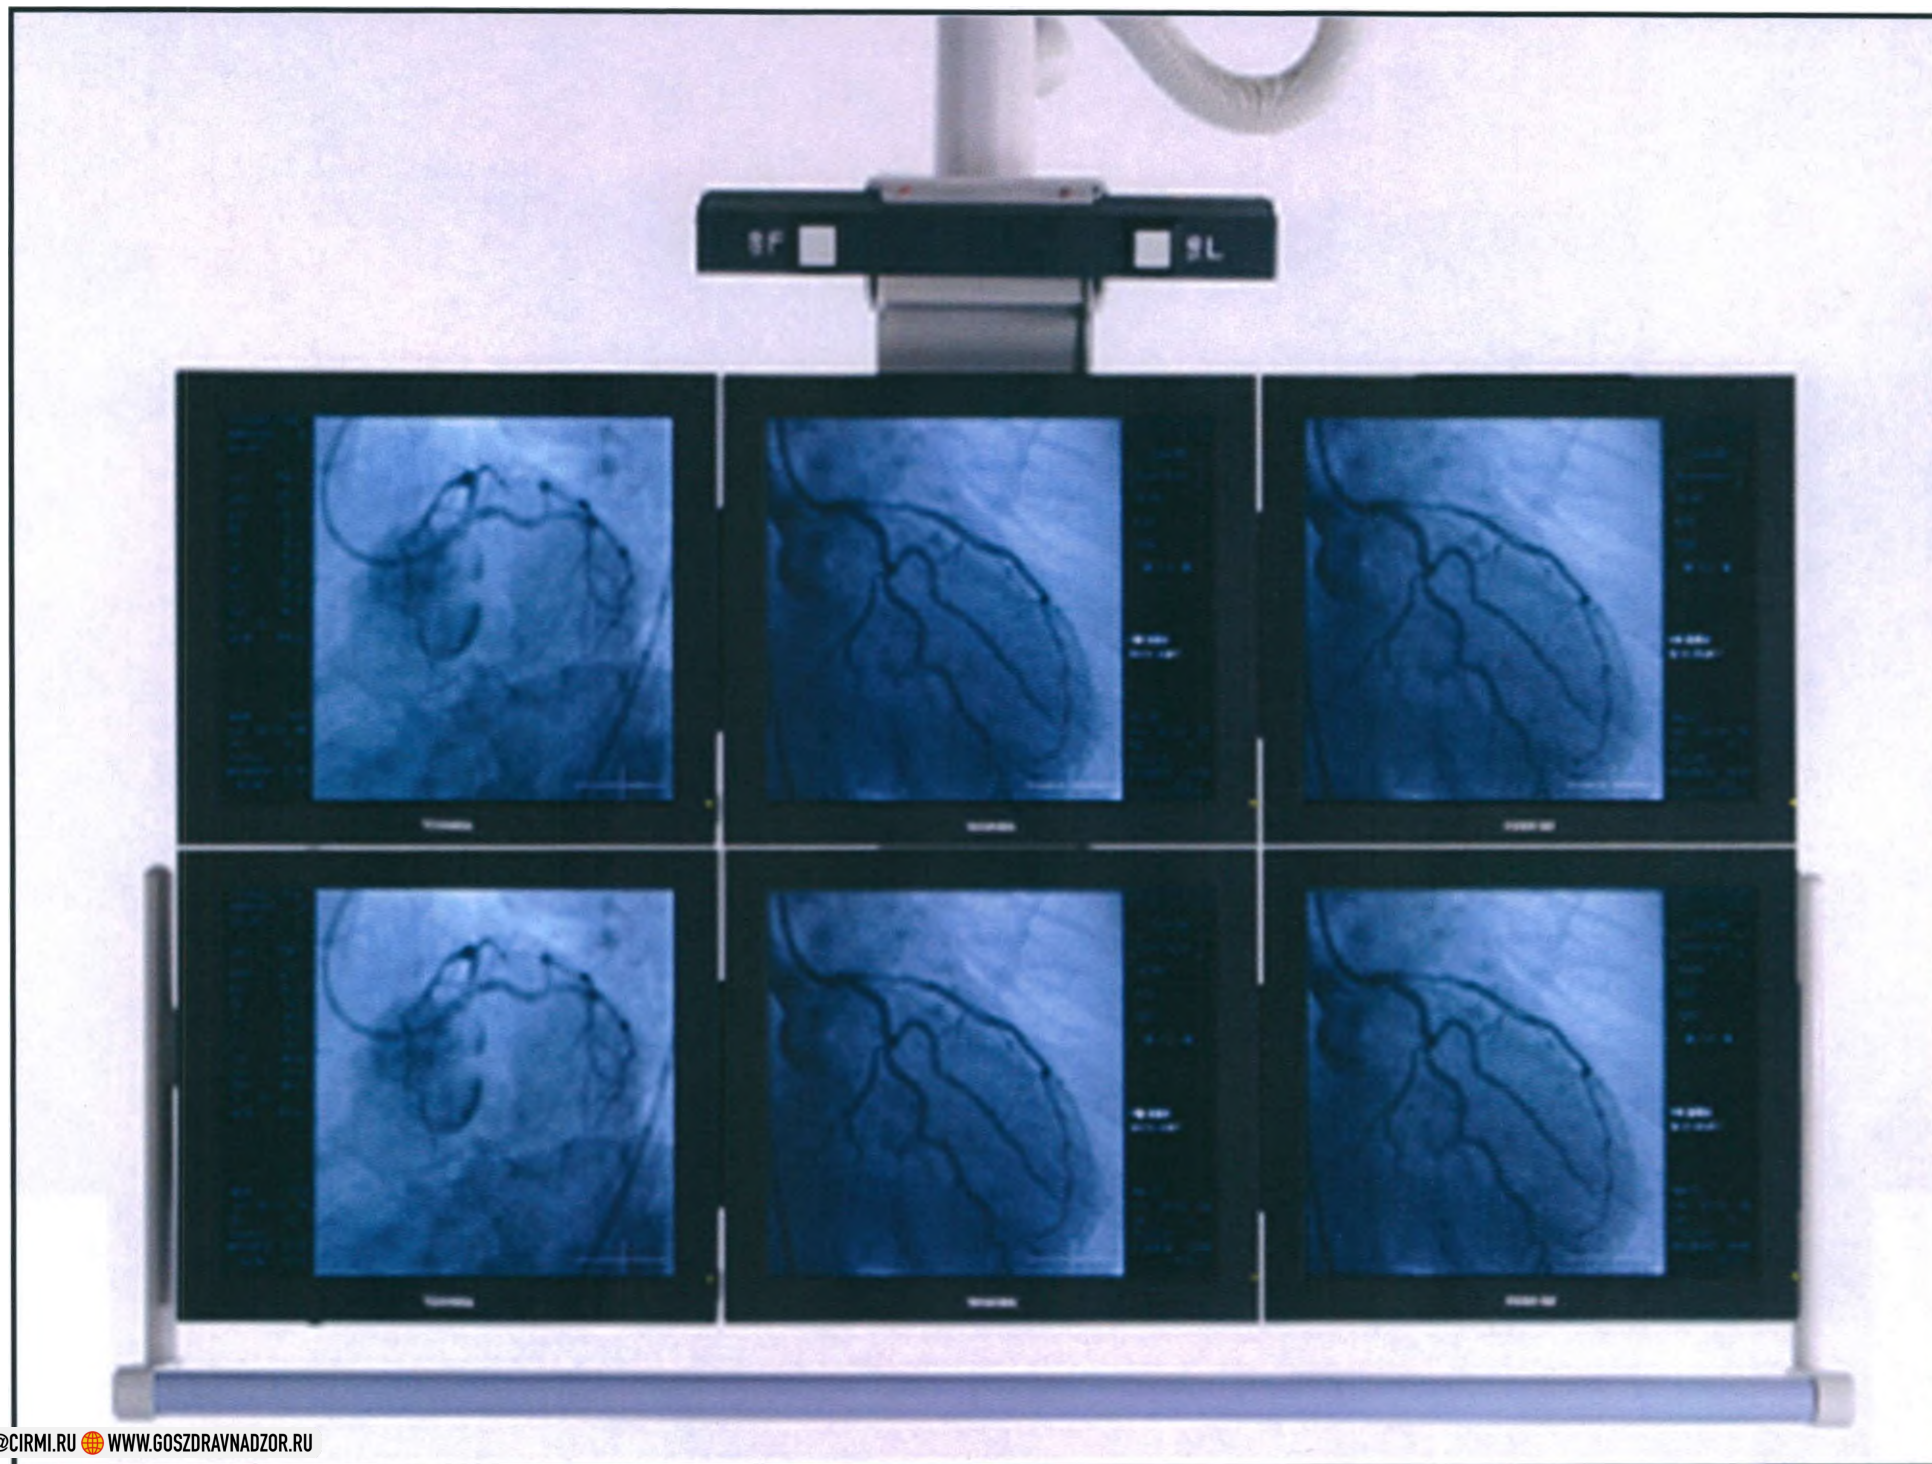


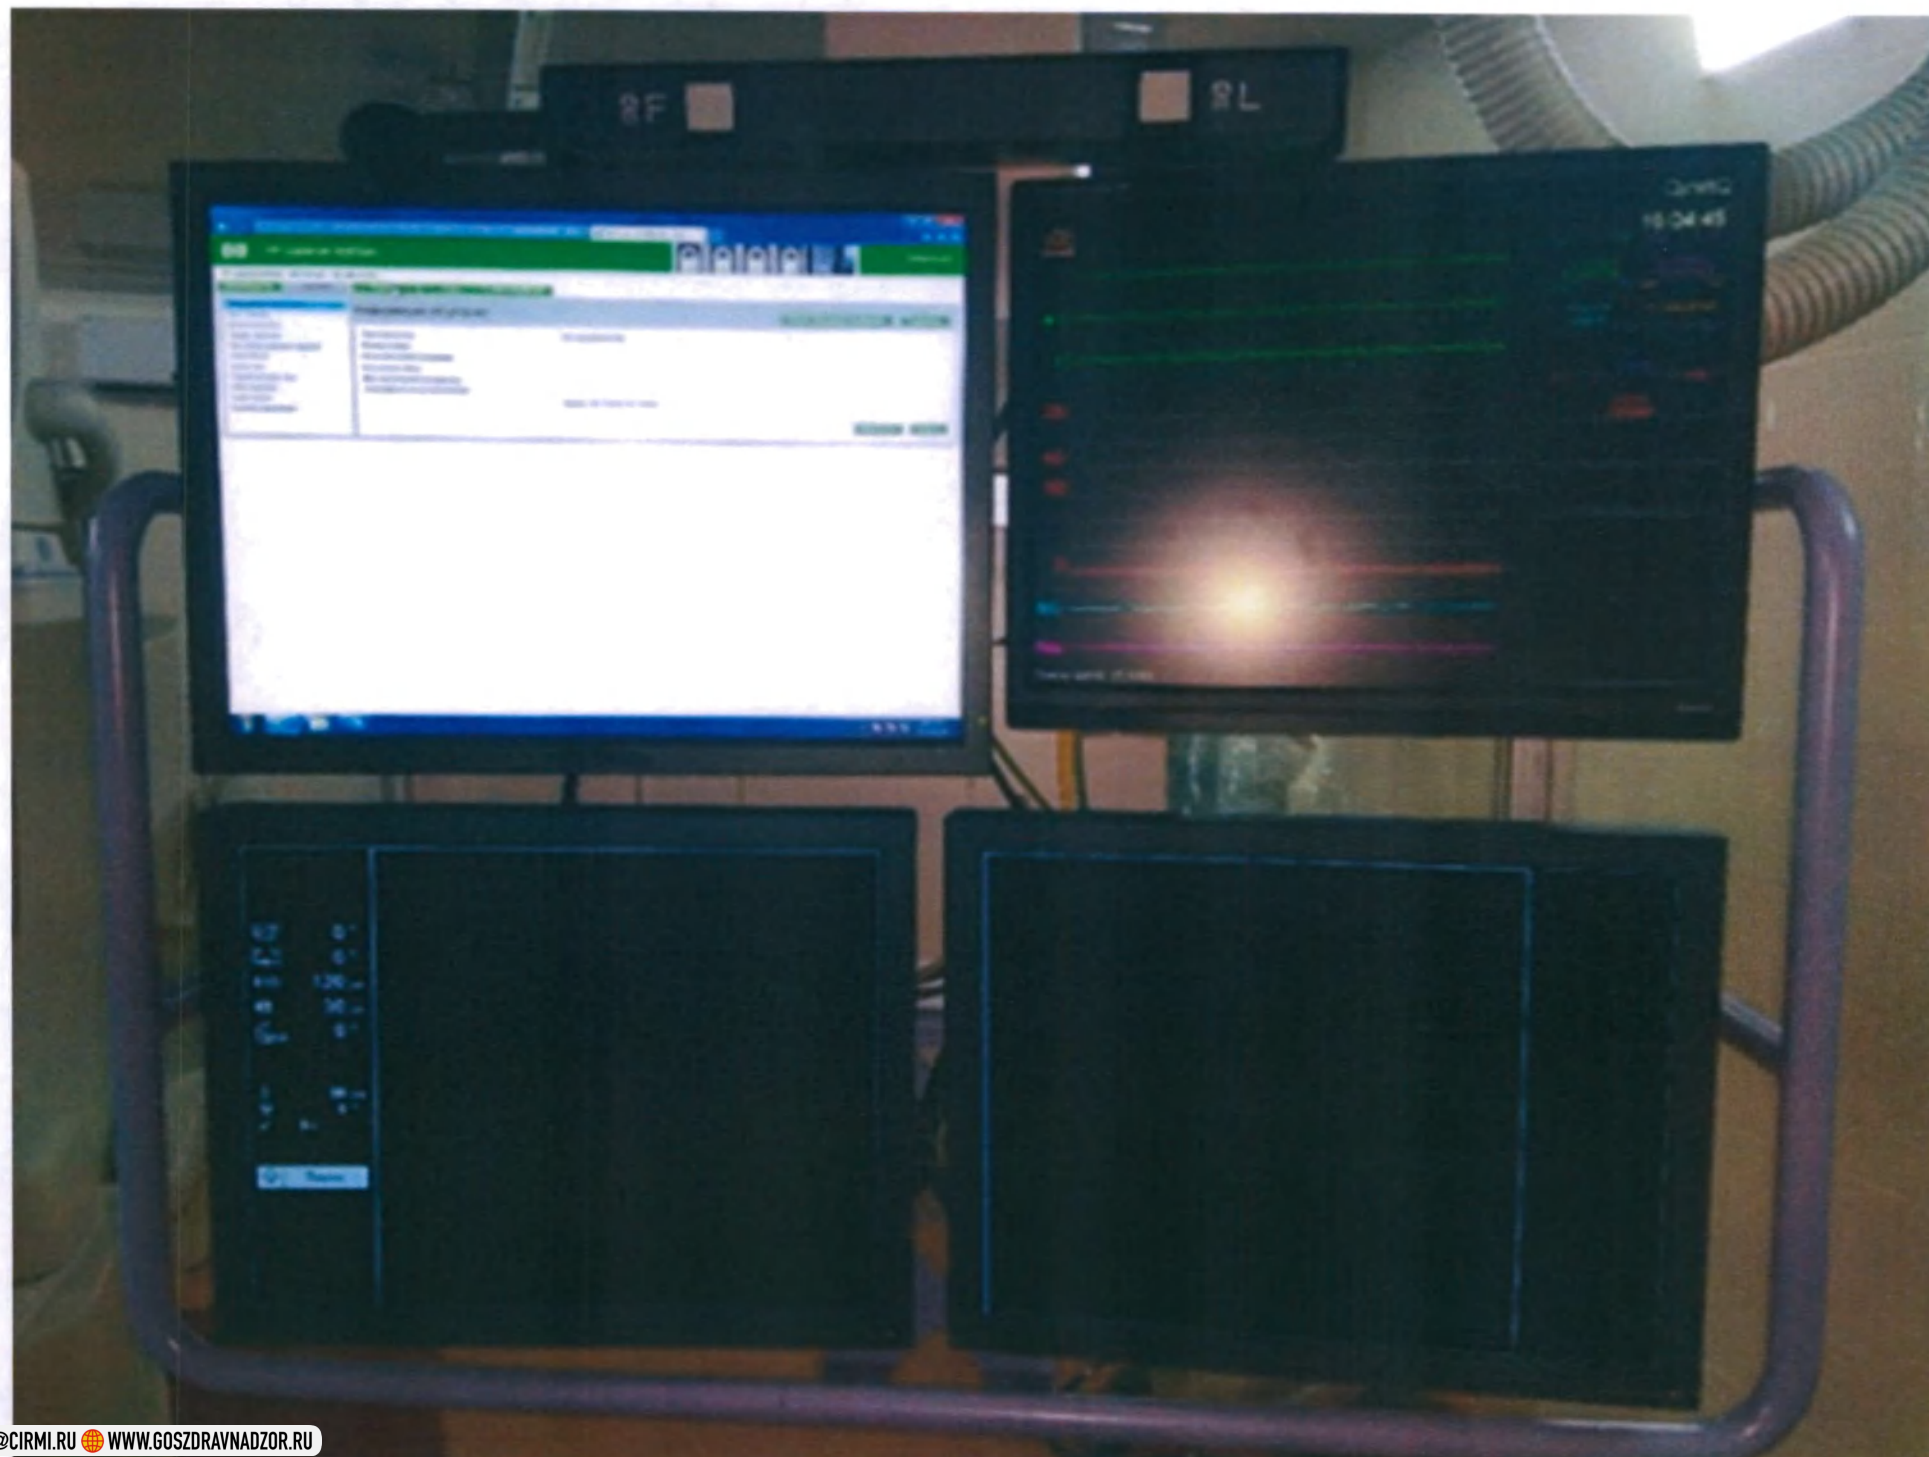

20. Подвесное устройство для мониторов.

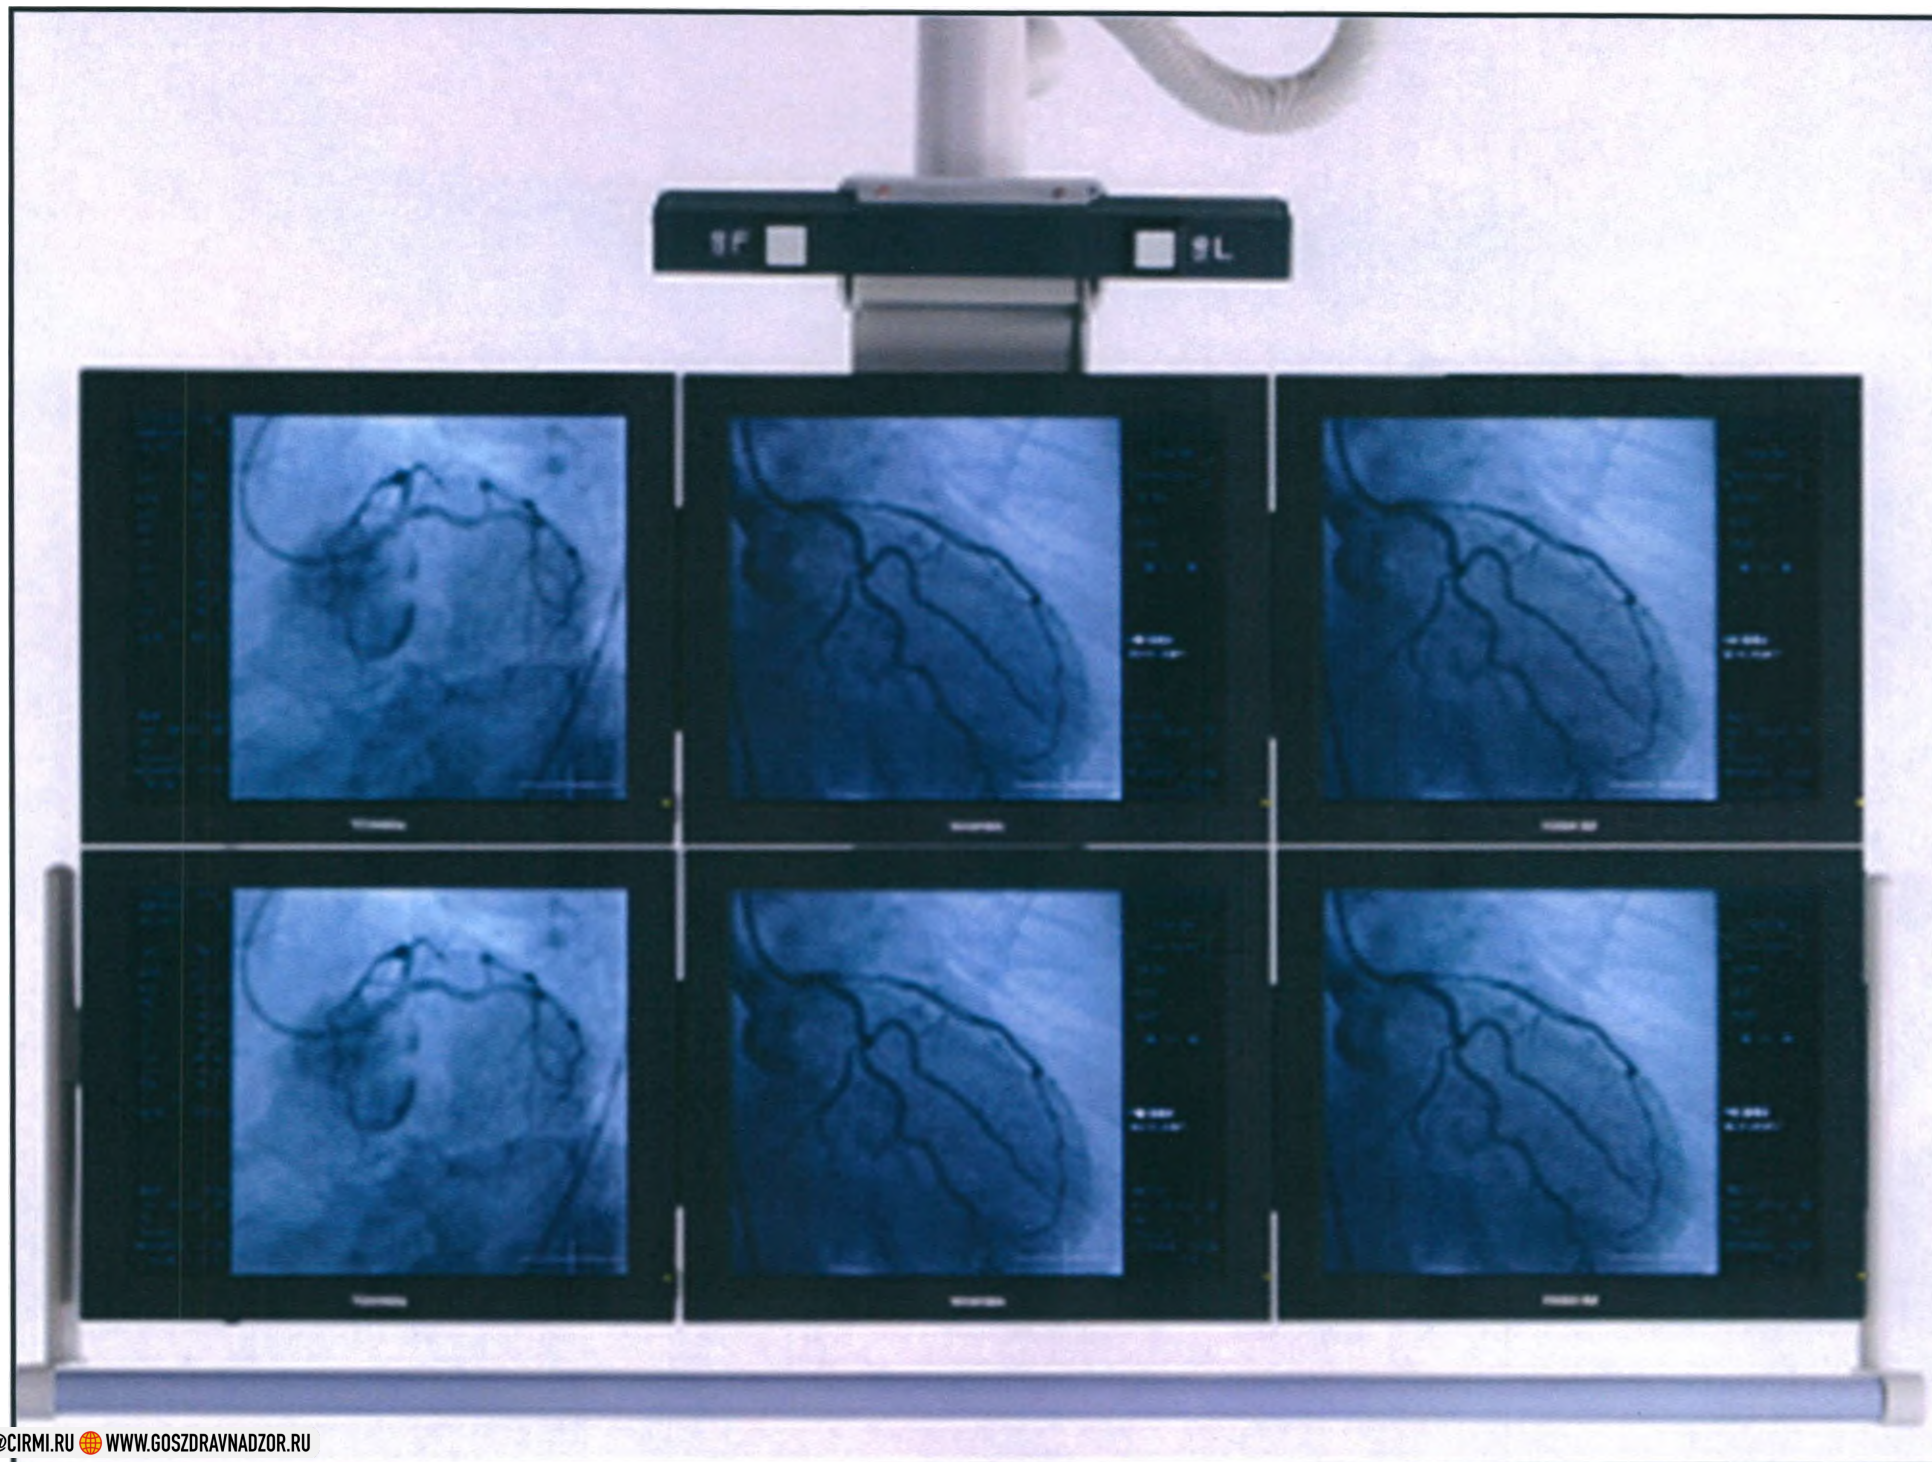

20. Подвесное устройство для мониторов.

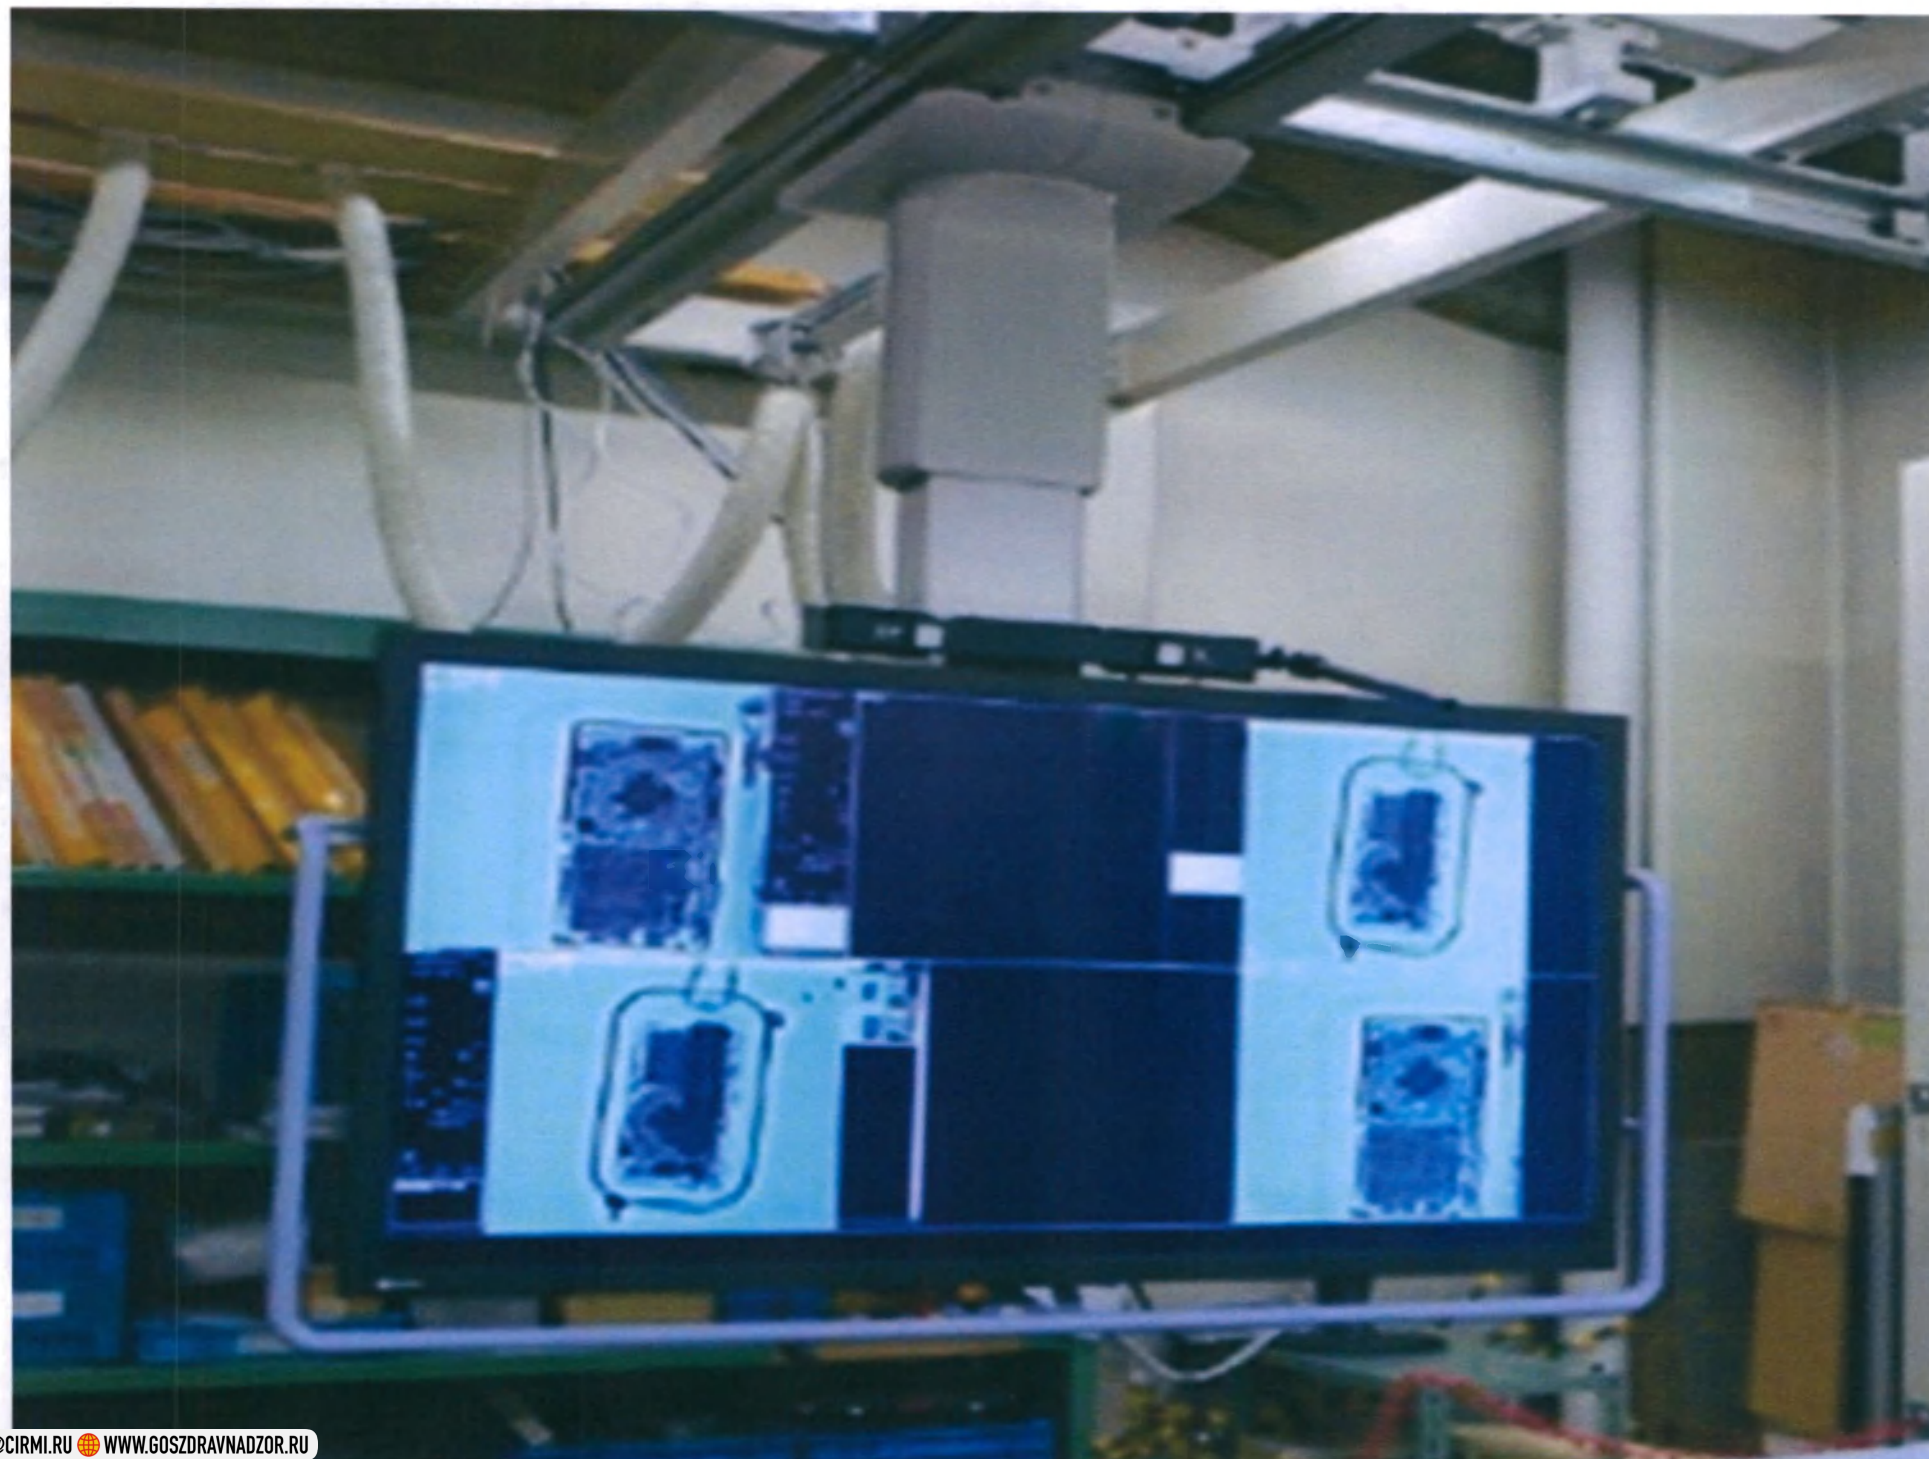

20. Подвесное устройство для мониторов.



21. Потолочные направляющие подвесного устройства для мониторов – 1 шт.





Микрофон в кабинете управления (talk microphone)



Усилитель звуковых сигналов в кабинете управления (talk amp)




Микрофон в кабинете сканирования (listen mic)




Усилитель звуковых сигналов в кабинете сканирования (listen amp)


23. Ионизационная камера дозиметра (производитель PTW-Freiburg, Германия).

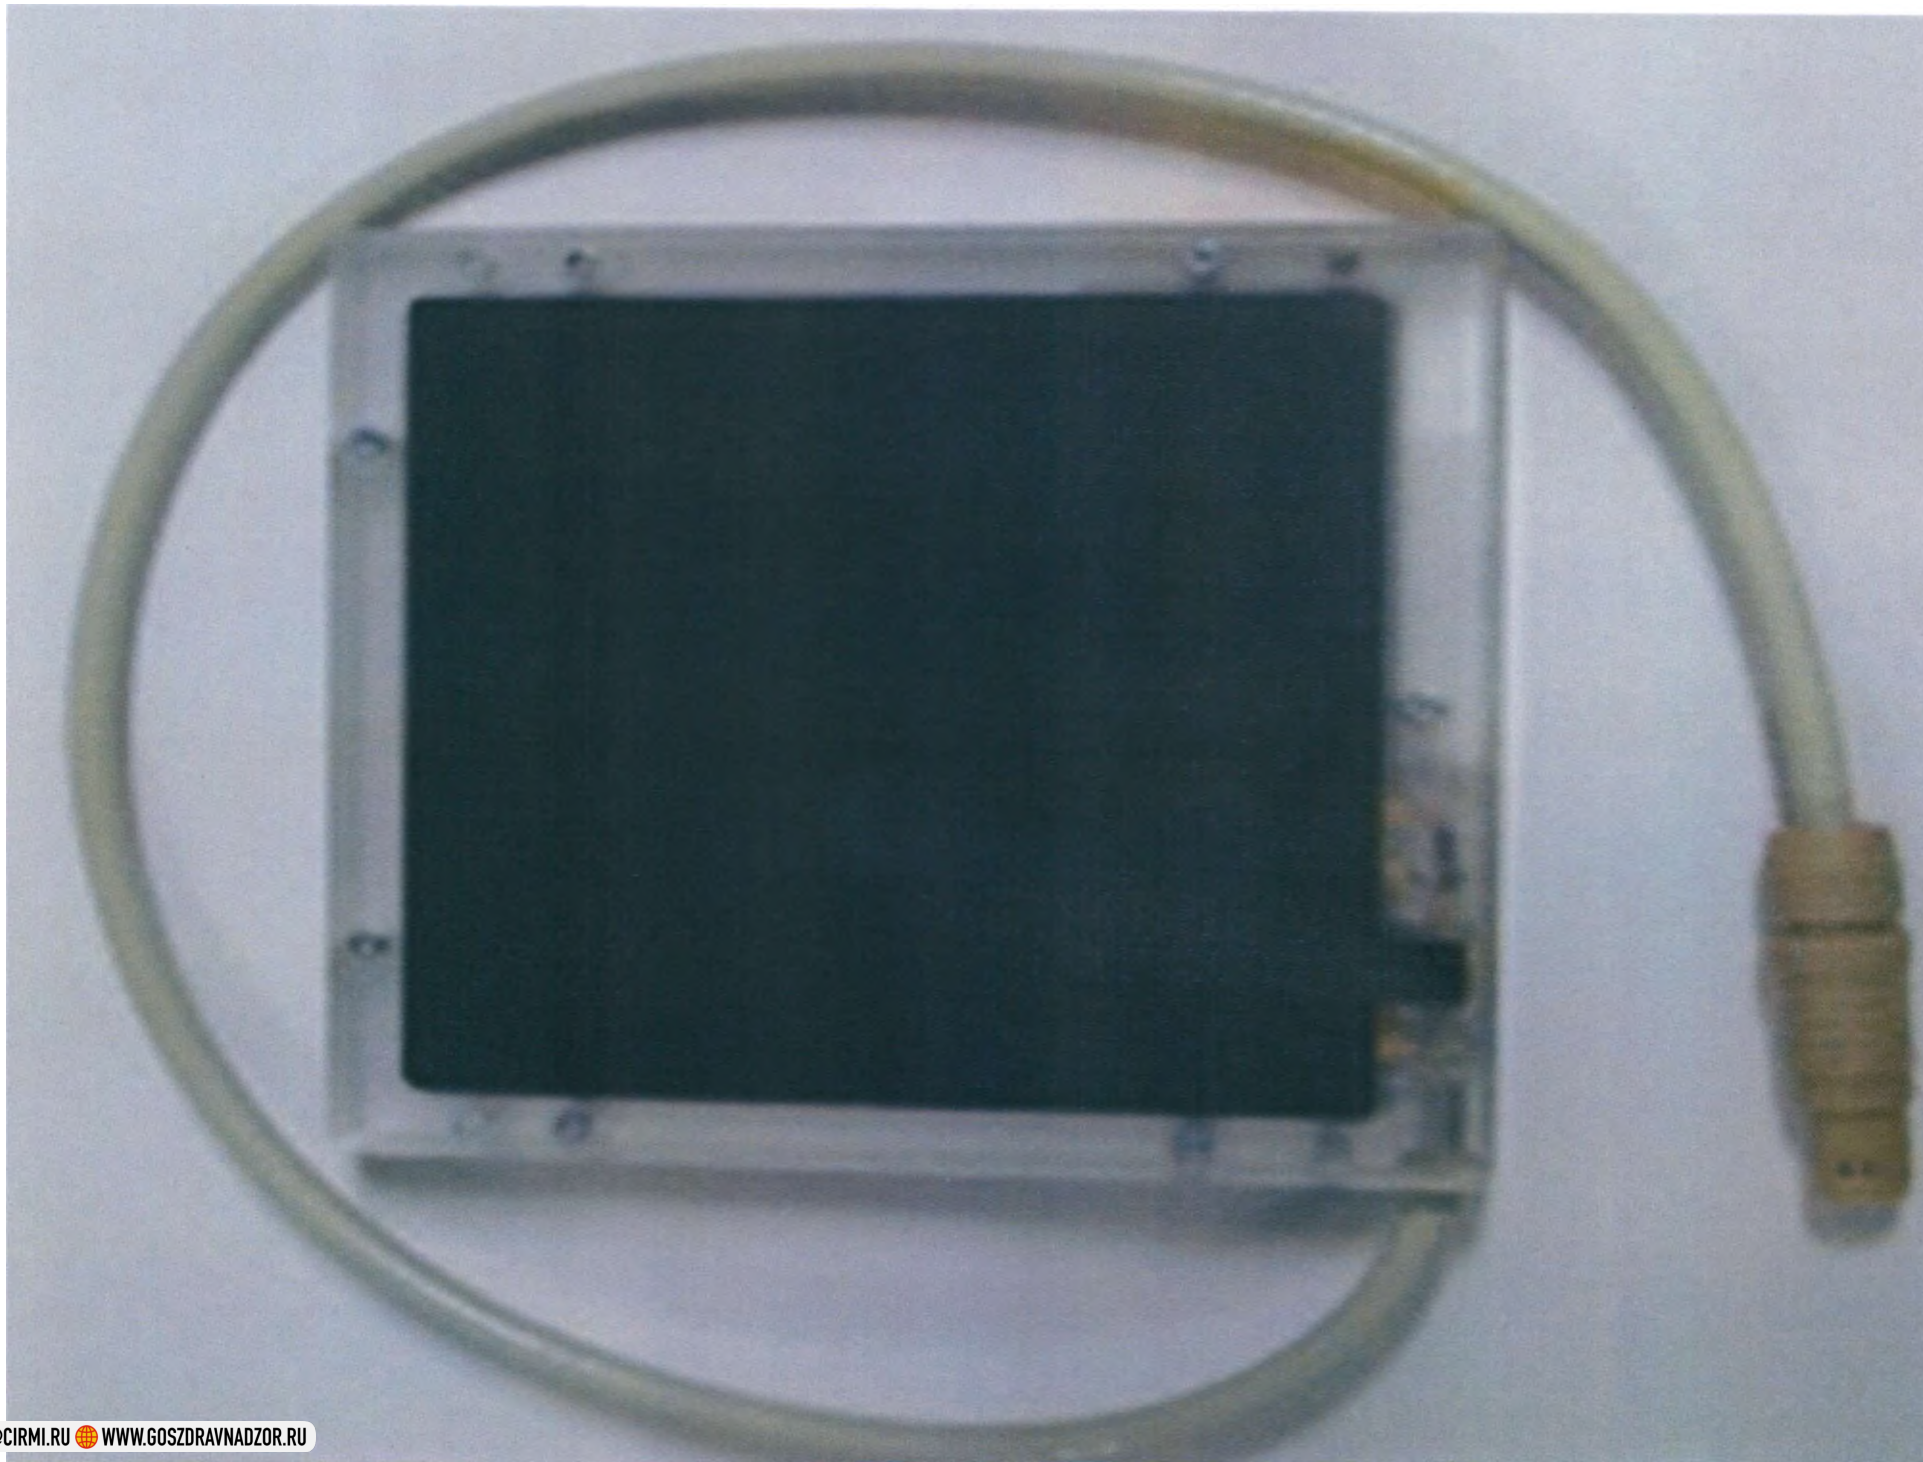


24. Дозиметр (производитель PTW-Freiburg, Германия).

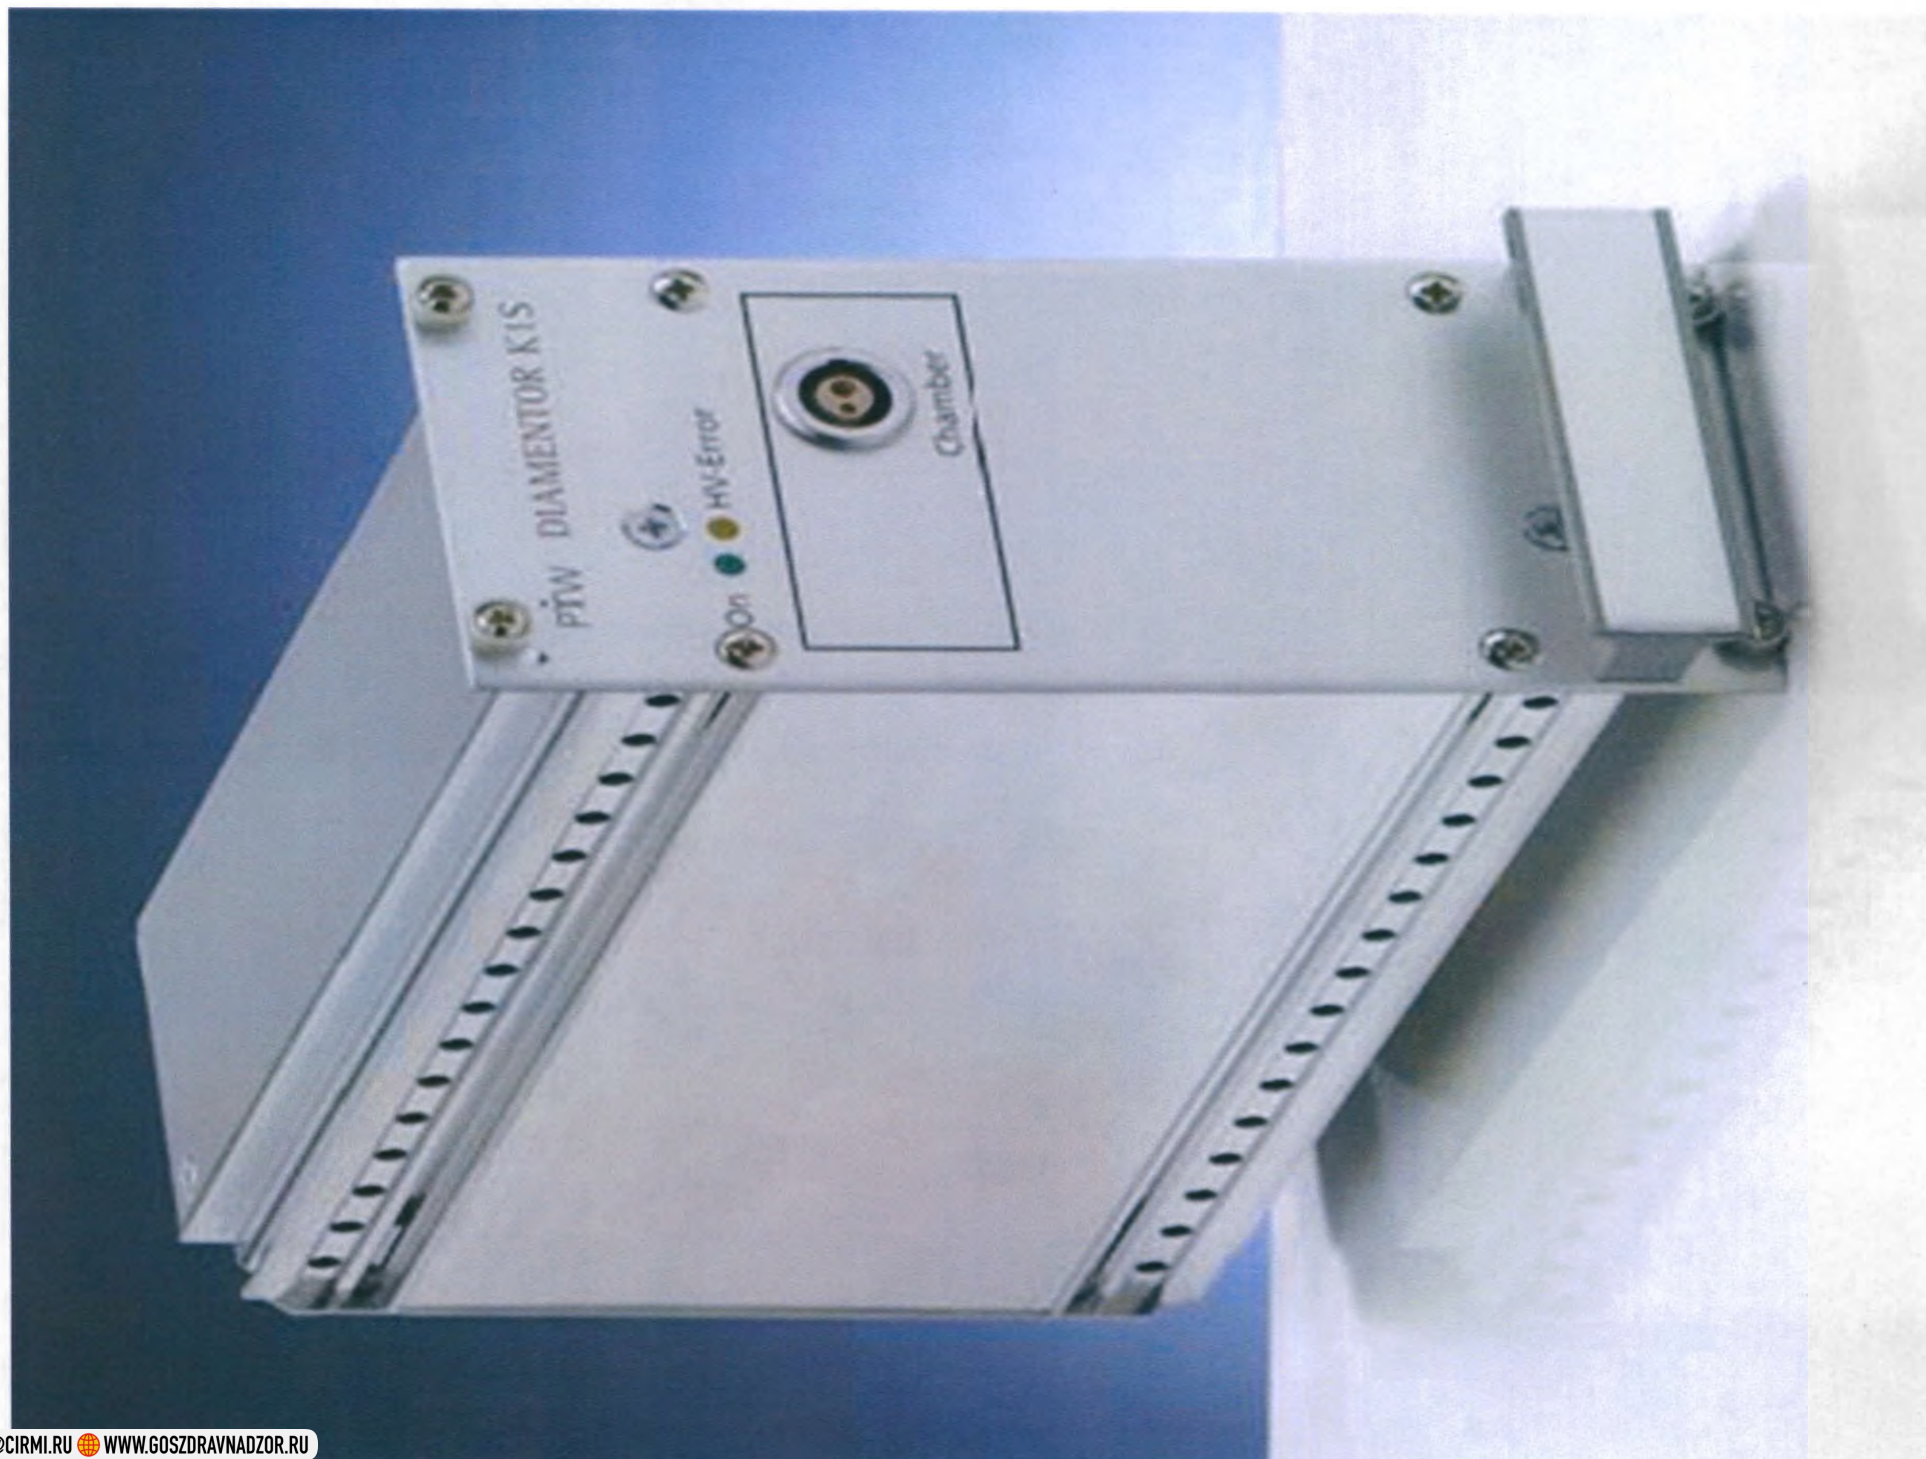


25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - усилитель – 1 шт.

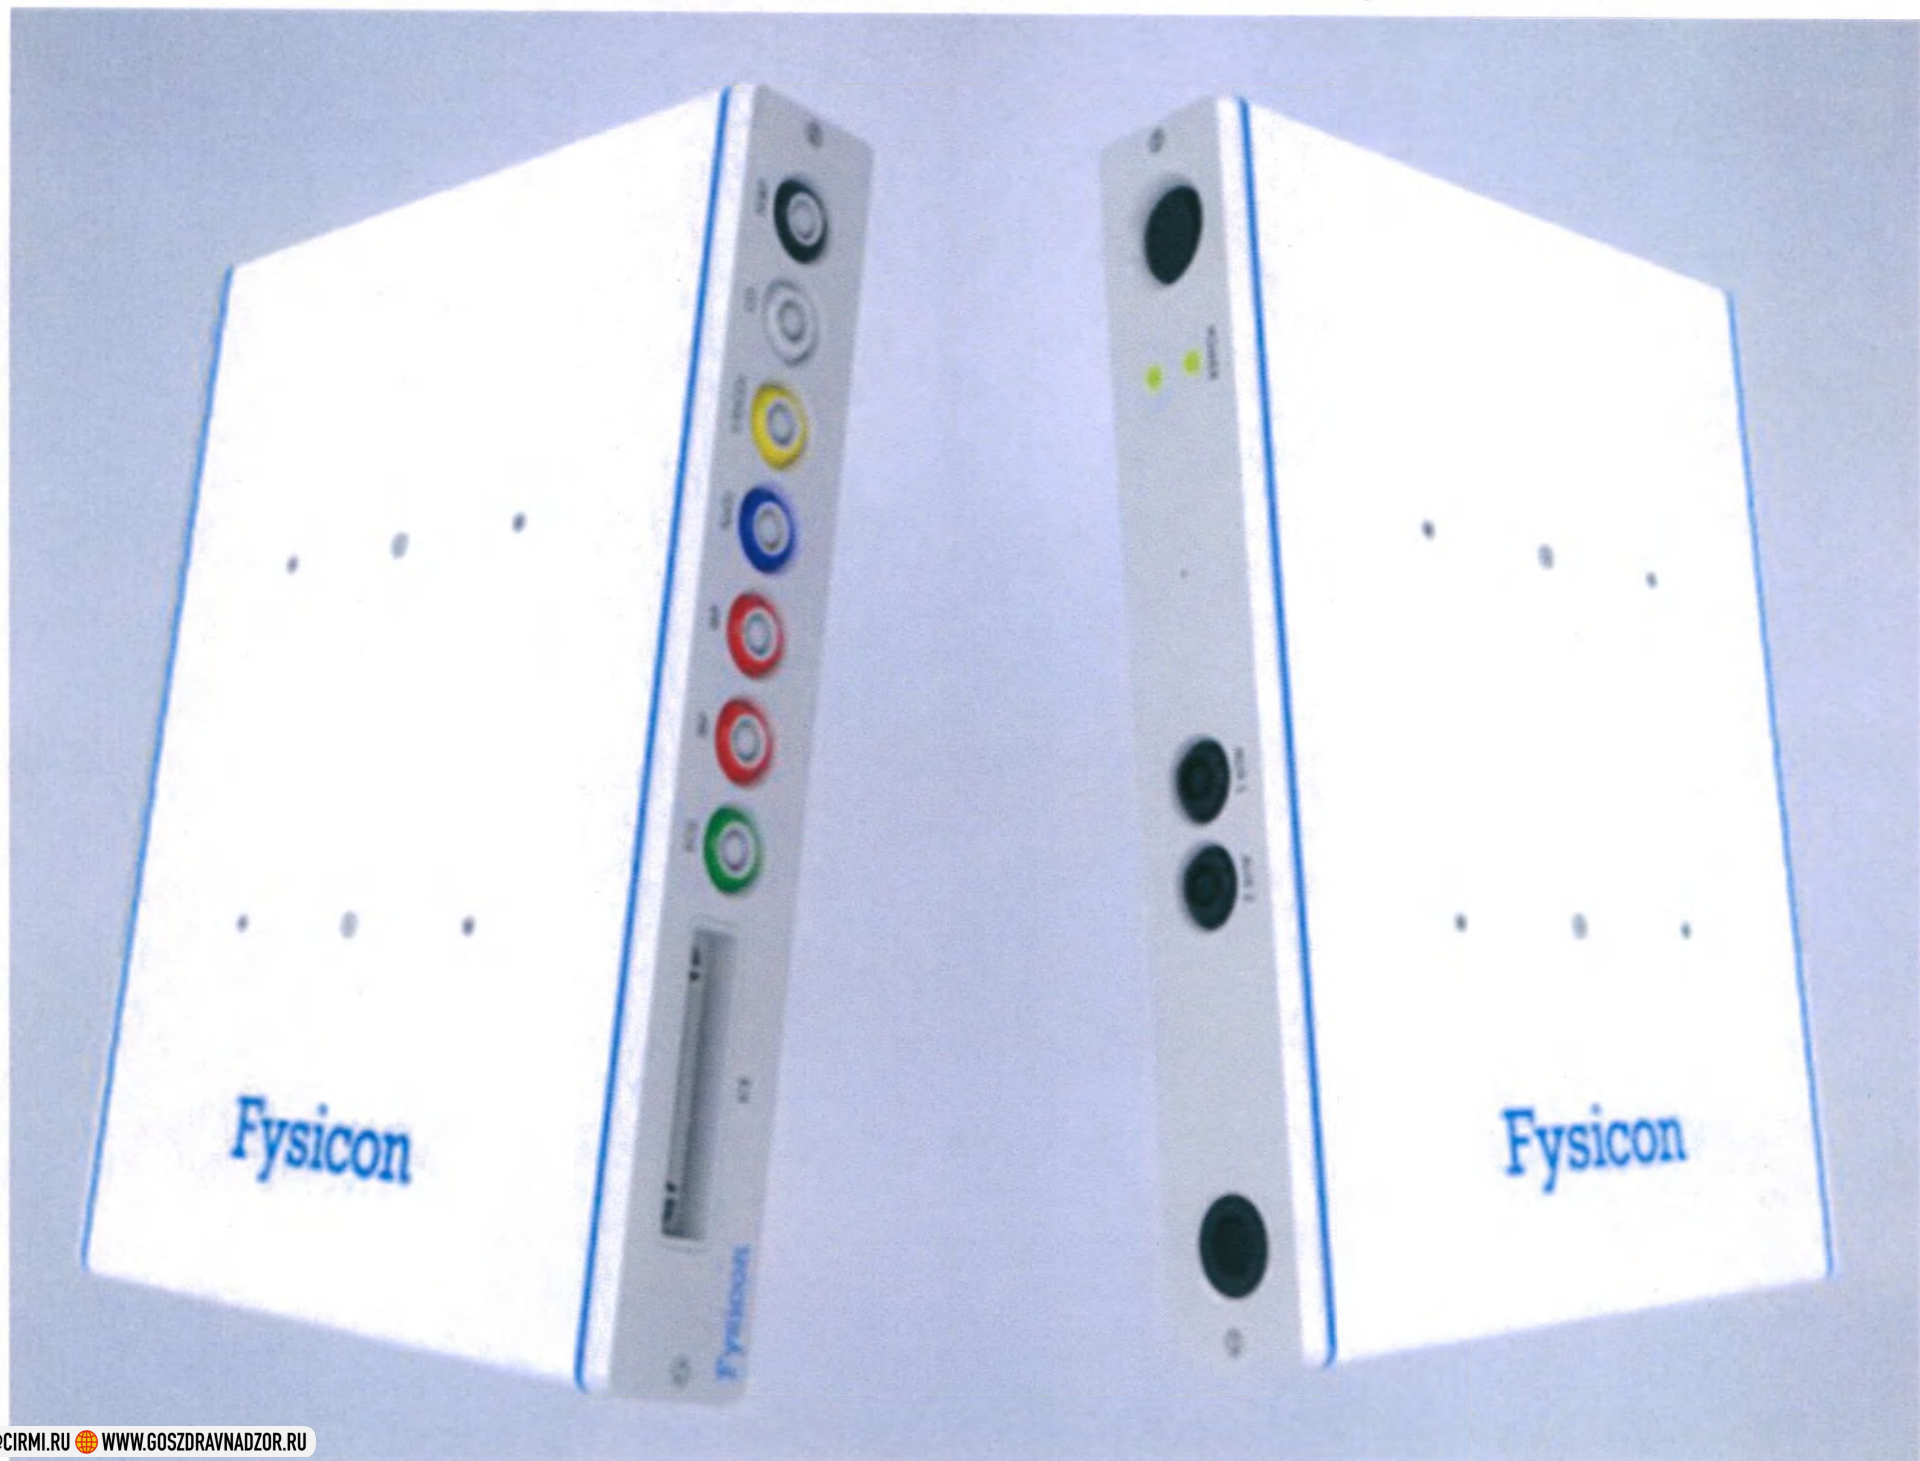



25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - крепеж для DIN-рейки - 1 шт.;

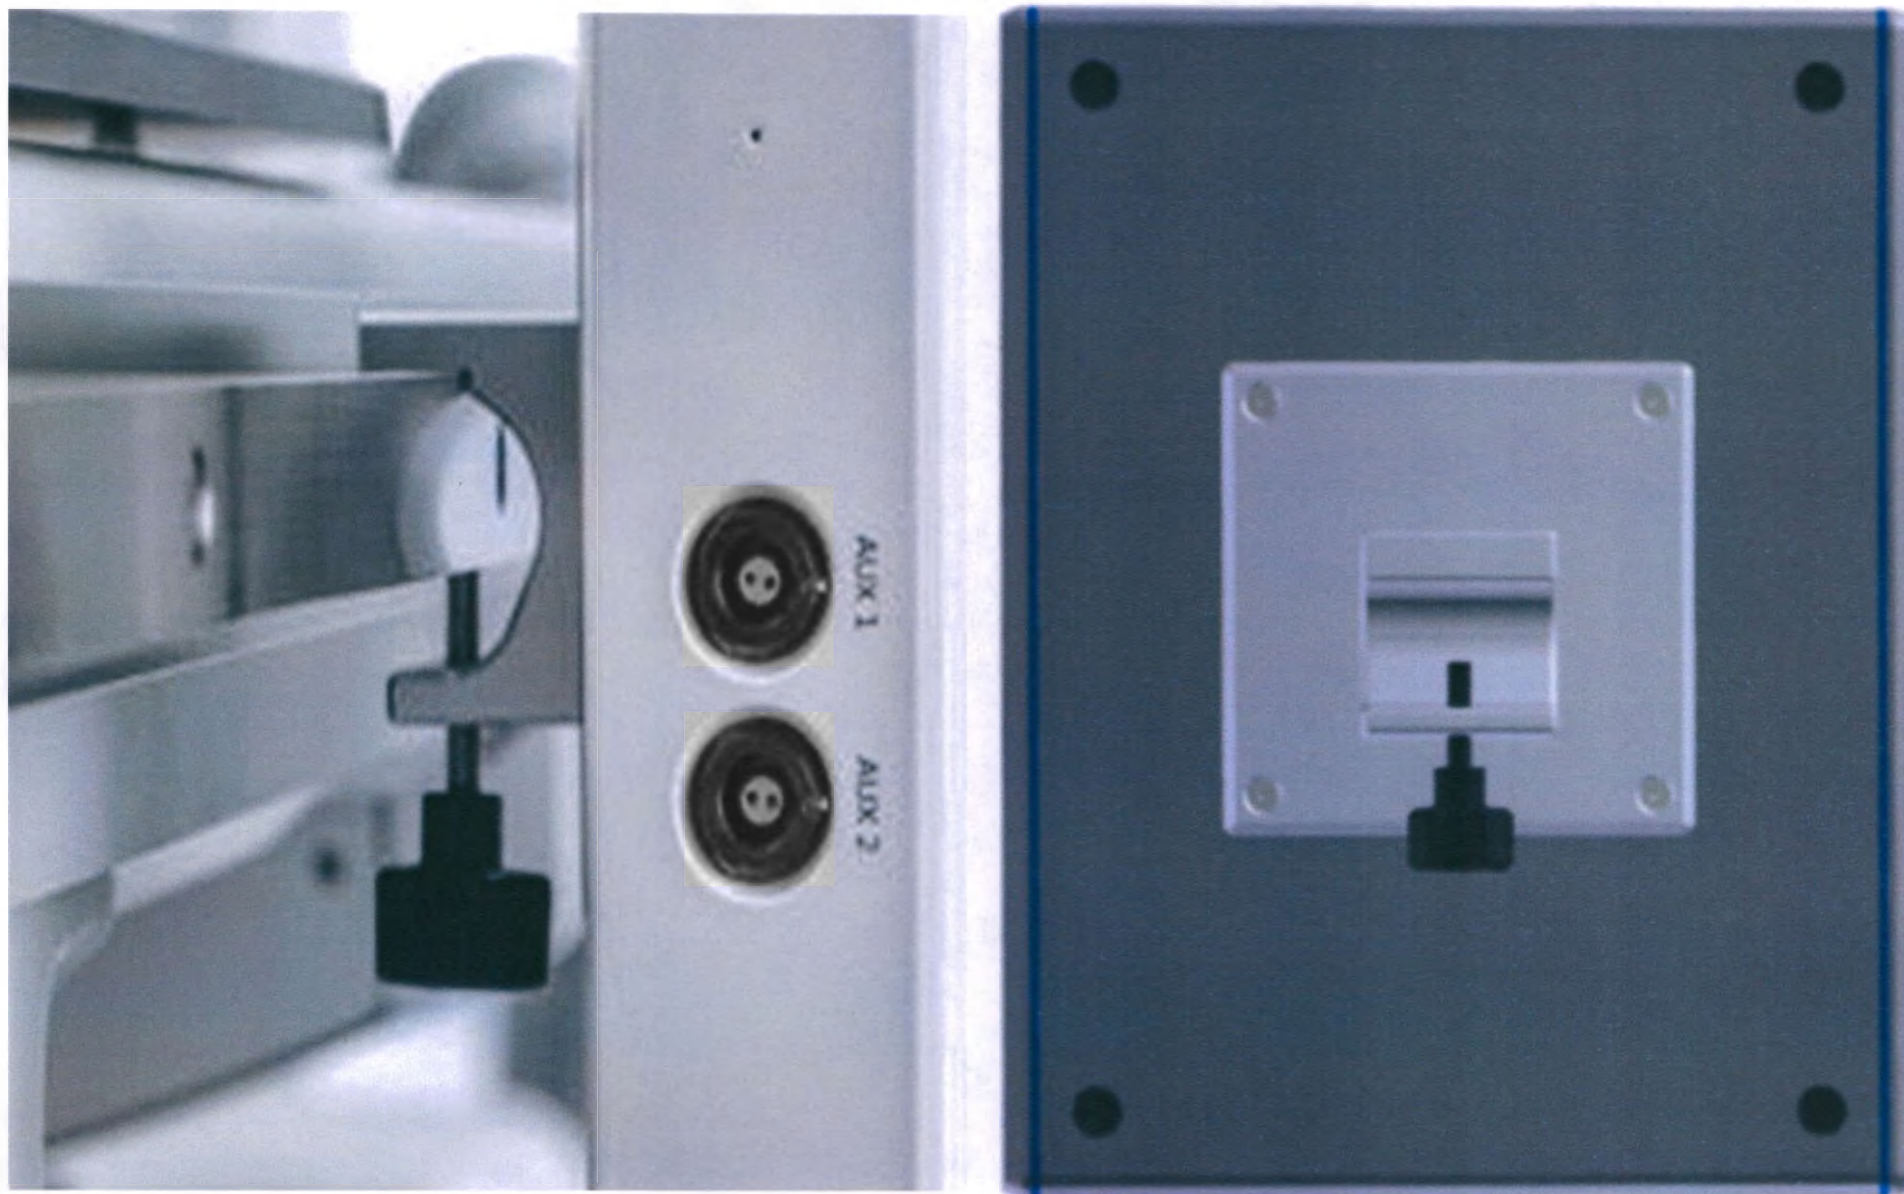

25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - процессор отчетов – 1 шт.; - процессор для работы в реальном времени (при необходимости), 1 шт.;

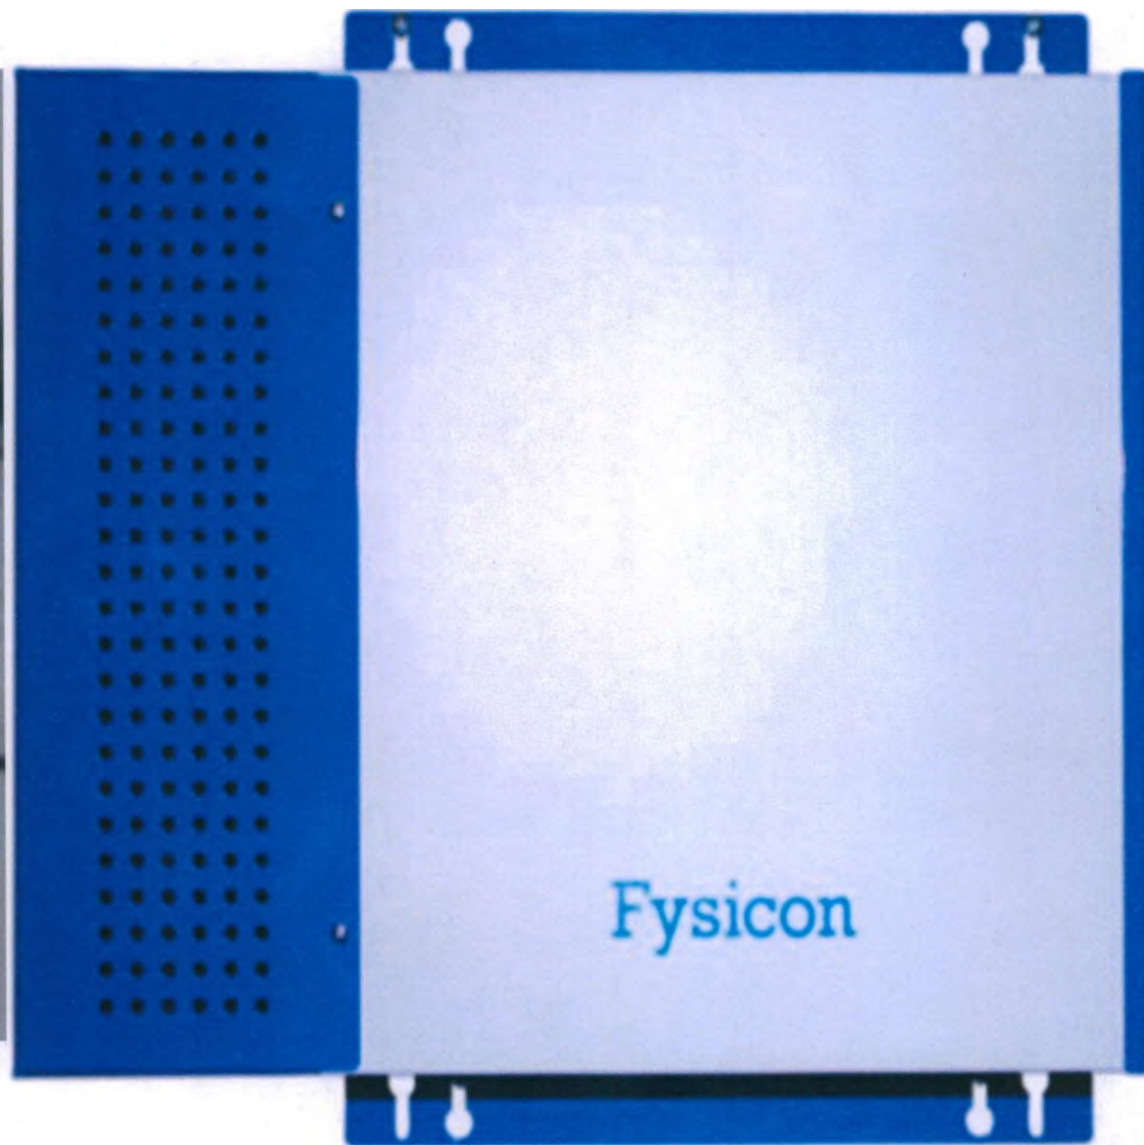

25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - кабель системы, не более 3 шт.

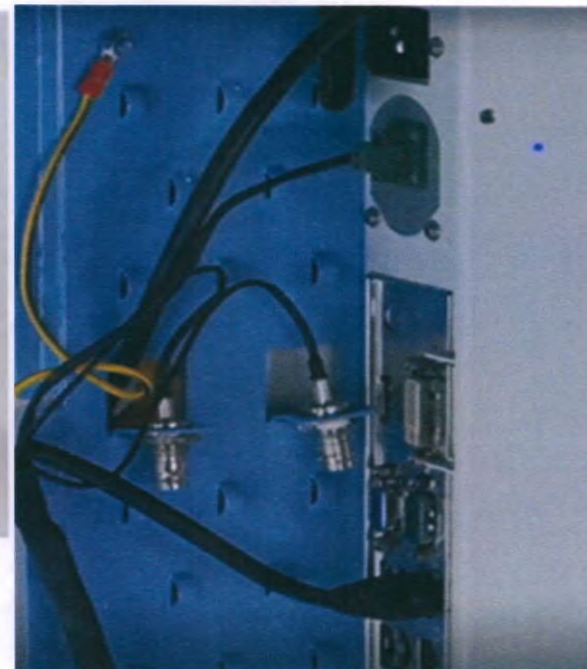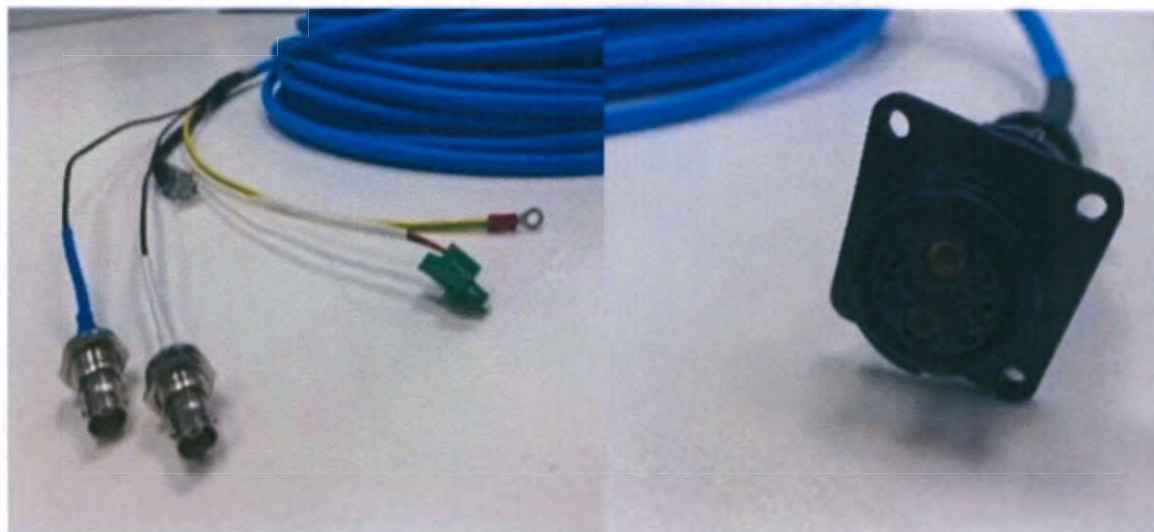

Кабель системы синий



Кабель системы белый

Кабель информационный зеленый

25. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - адаптер питания, не более 3 шт.



Canon

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Alphenix

**МОДЕЛЬ INFX-8000V/B, INFX-8000V/Y,
INFX-8000V/P**

ВАЖНО!

Перед эксплуатацией оборудования ознакомьтесь
с настоящим руководством. После прочтения
держите руководство в легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION


© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2018–2020

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Принадлежности: 1. Вспомогательная консоль.



Принадлежности: 1. Вспомогательная консоль (Подставка).

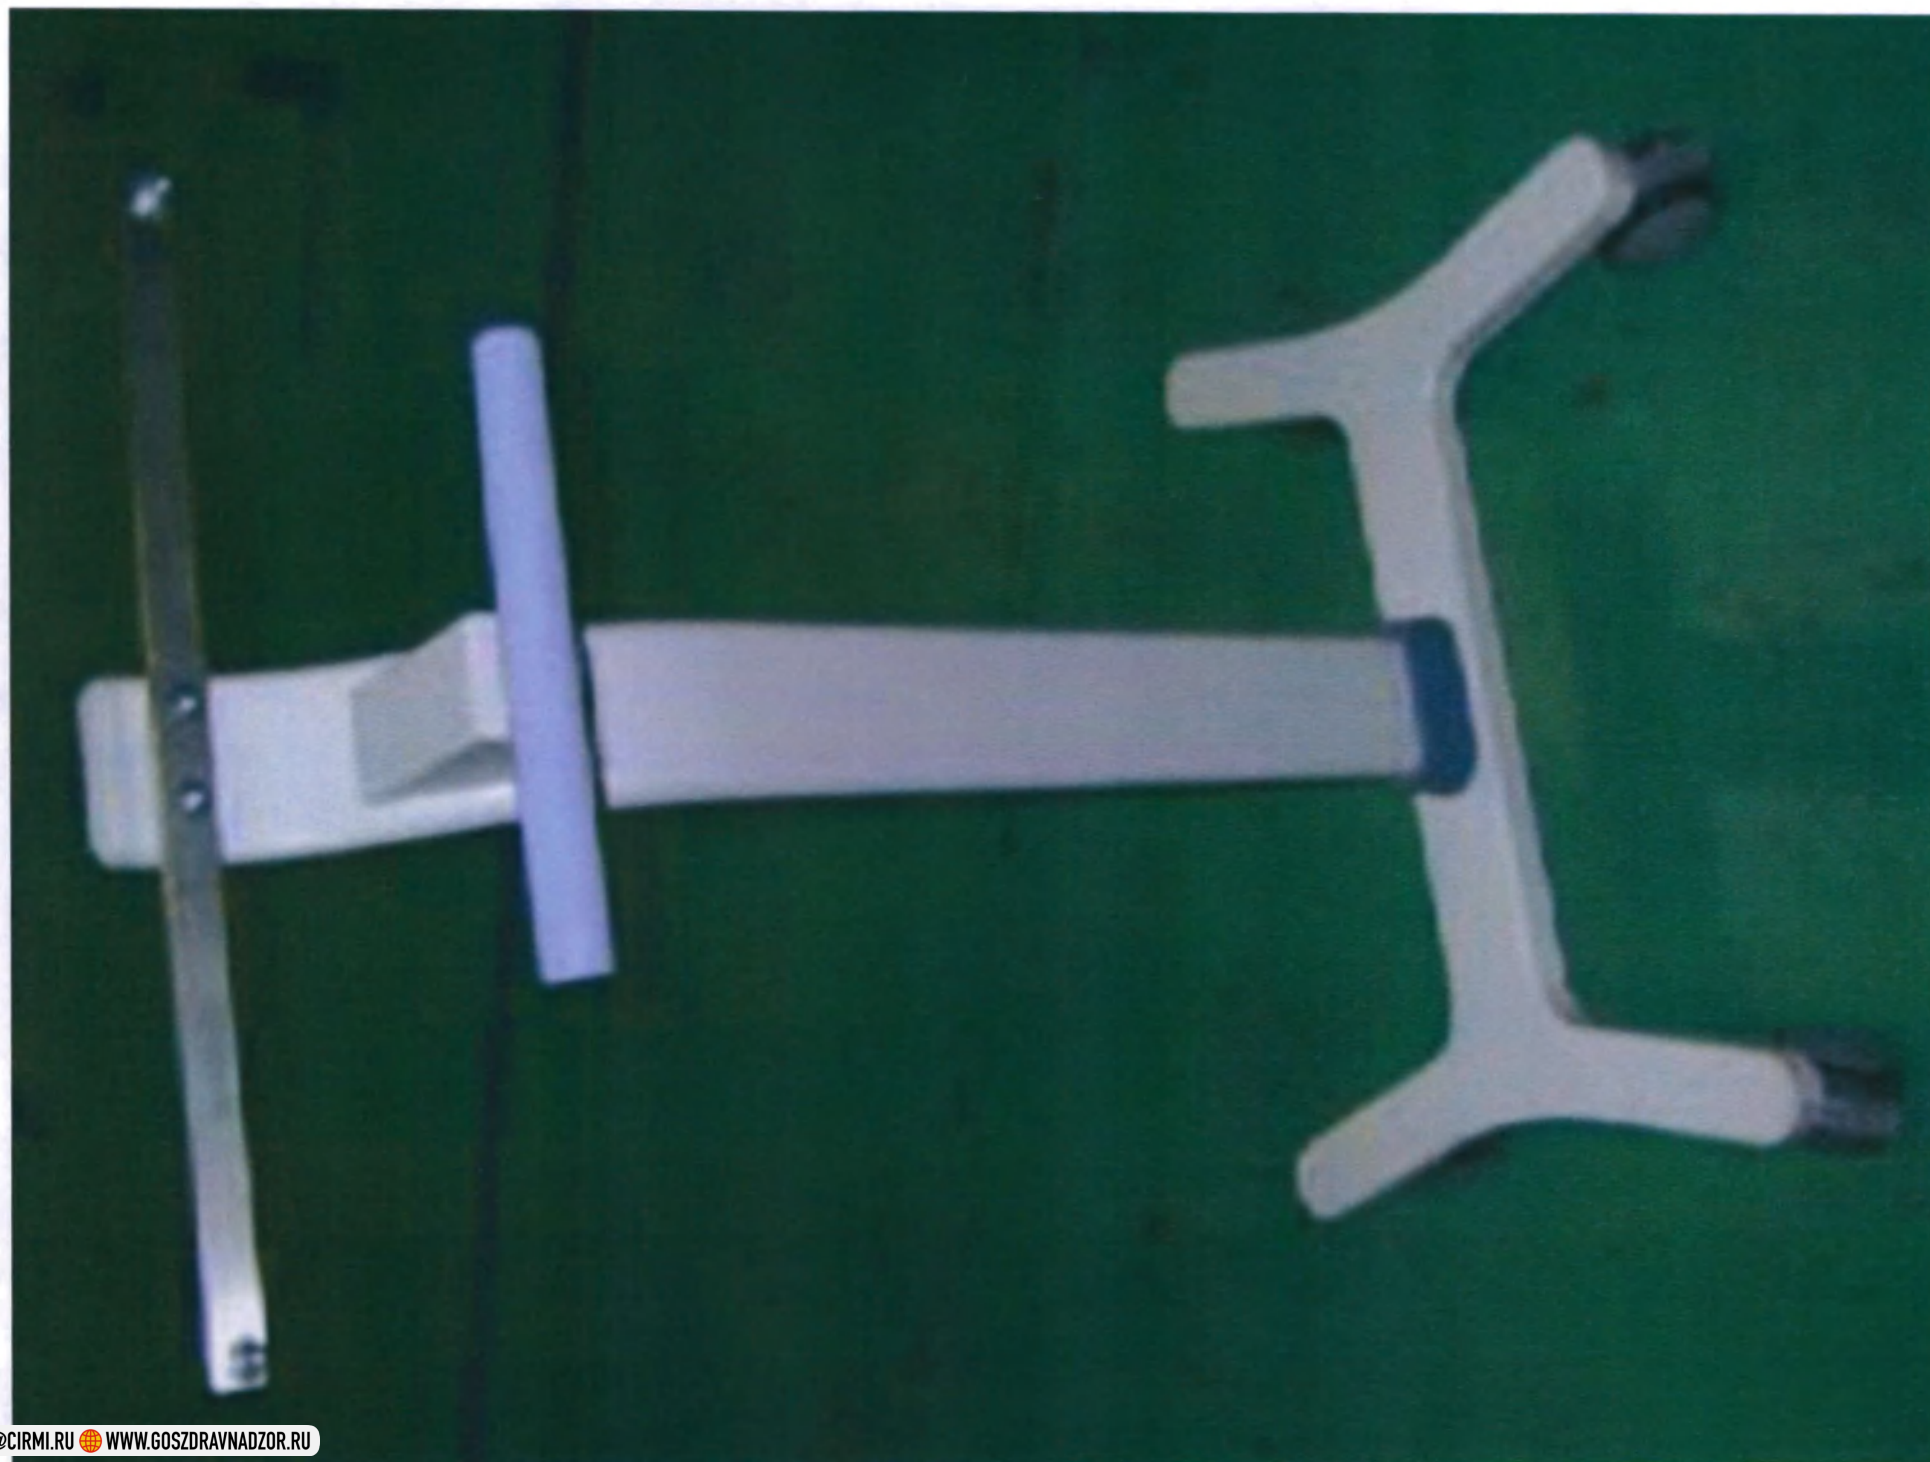



2. Боковая консоль стола (для использования в сочетании с планшетной консолью).



3. Вспомогательная консоль (для использования в сочетании с планшетной консолью).



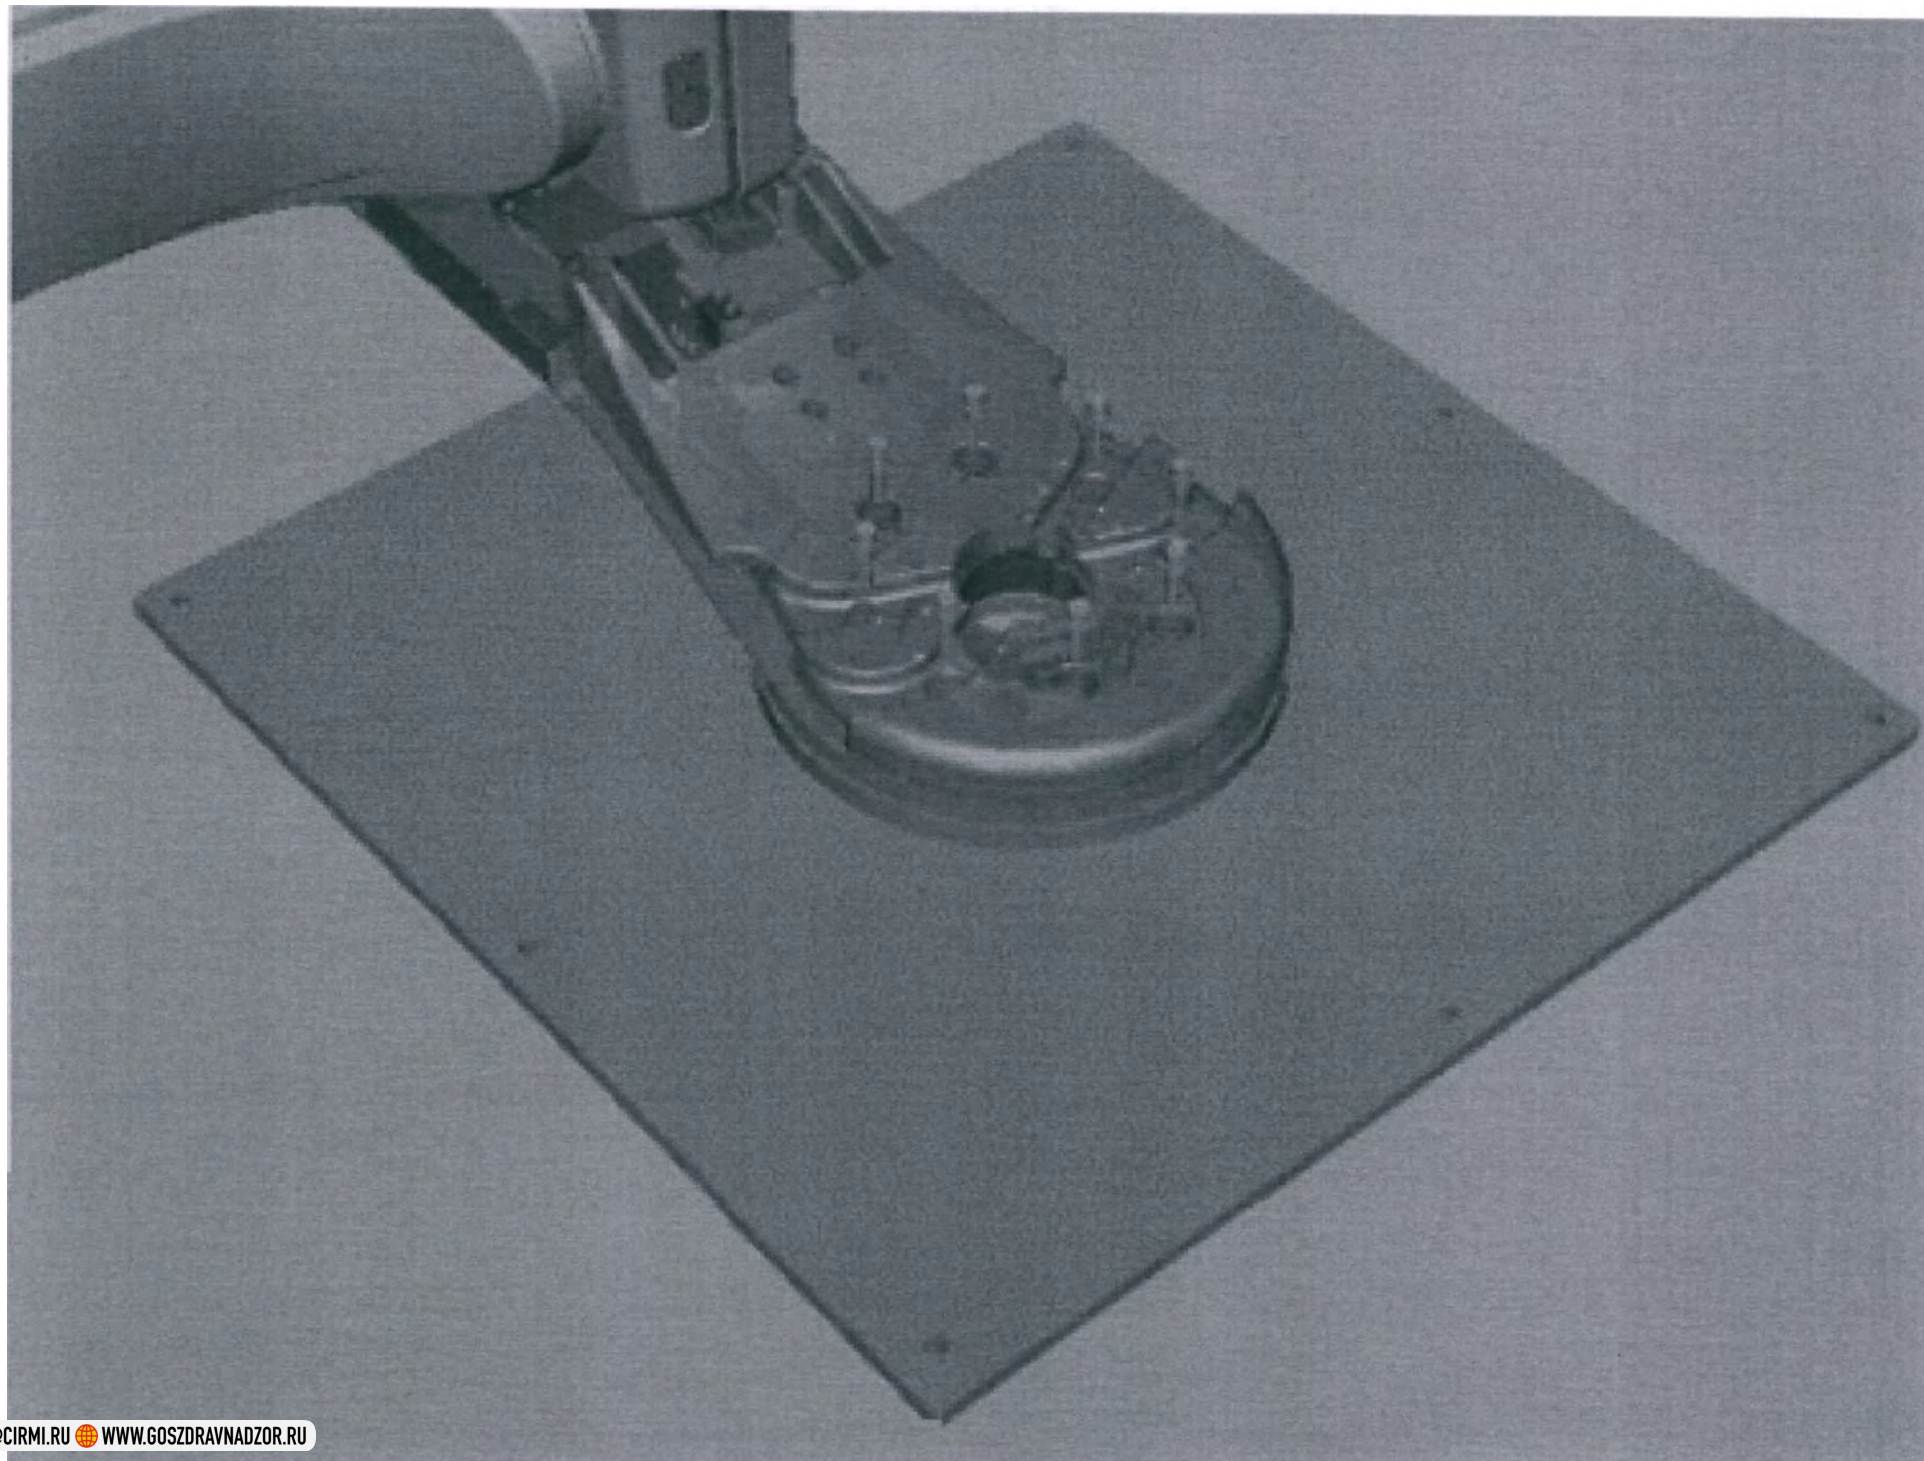

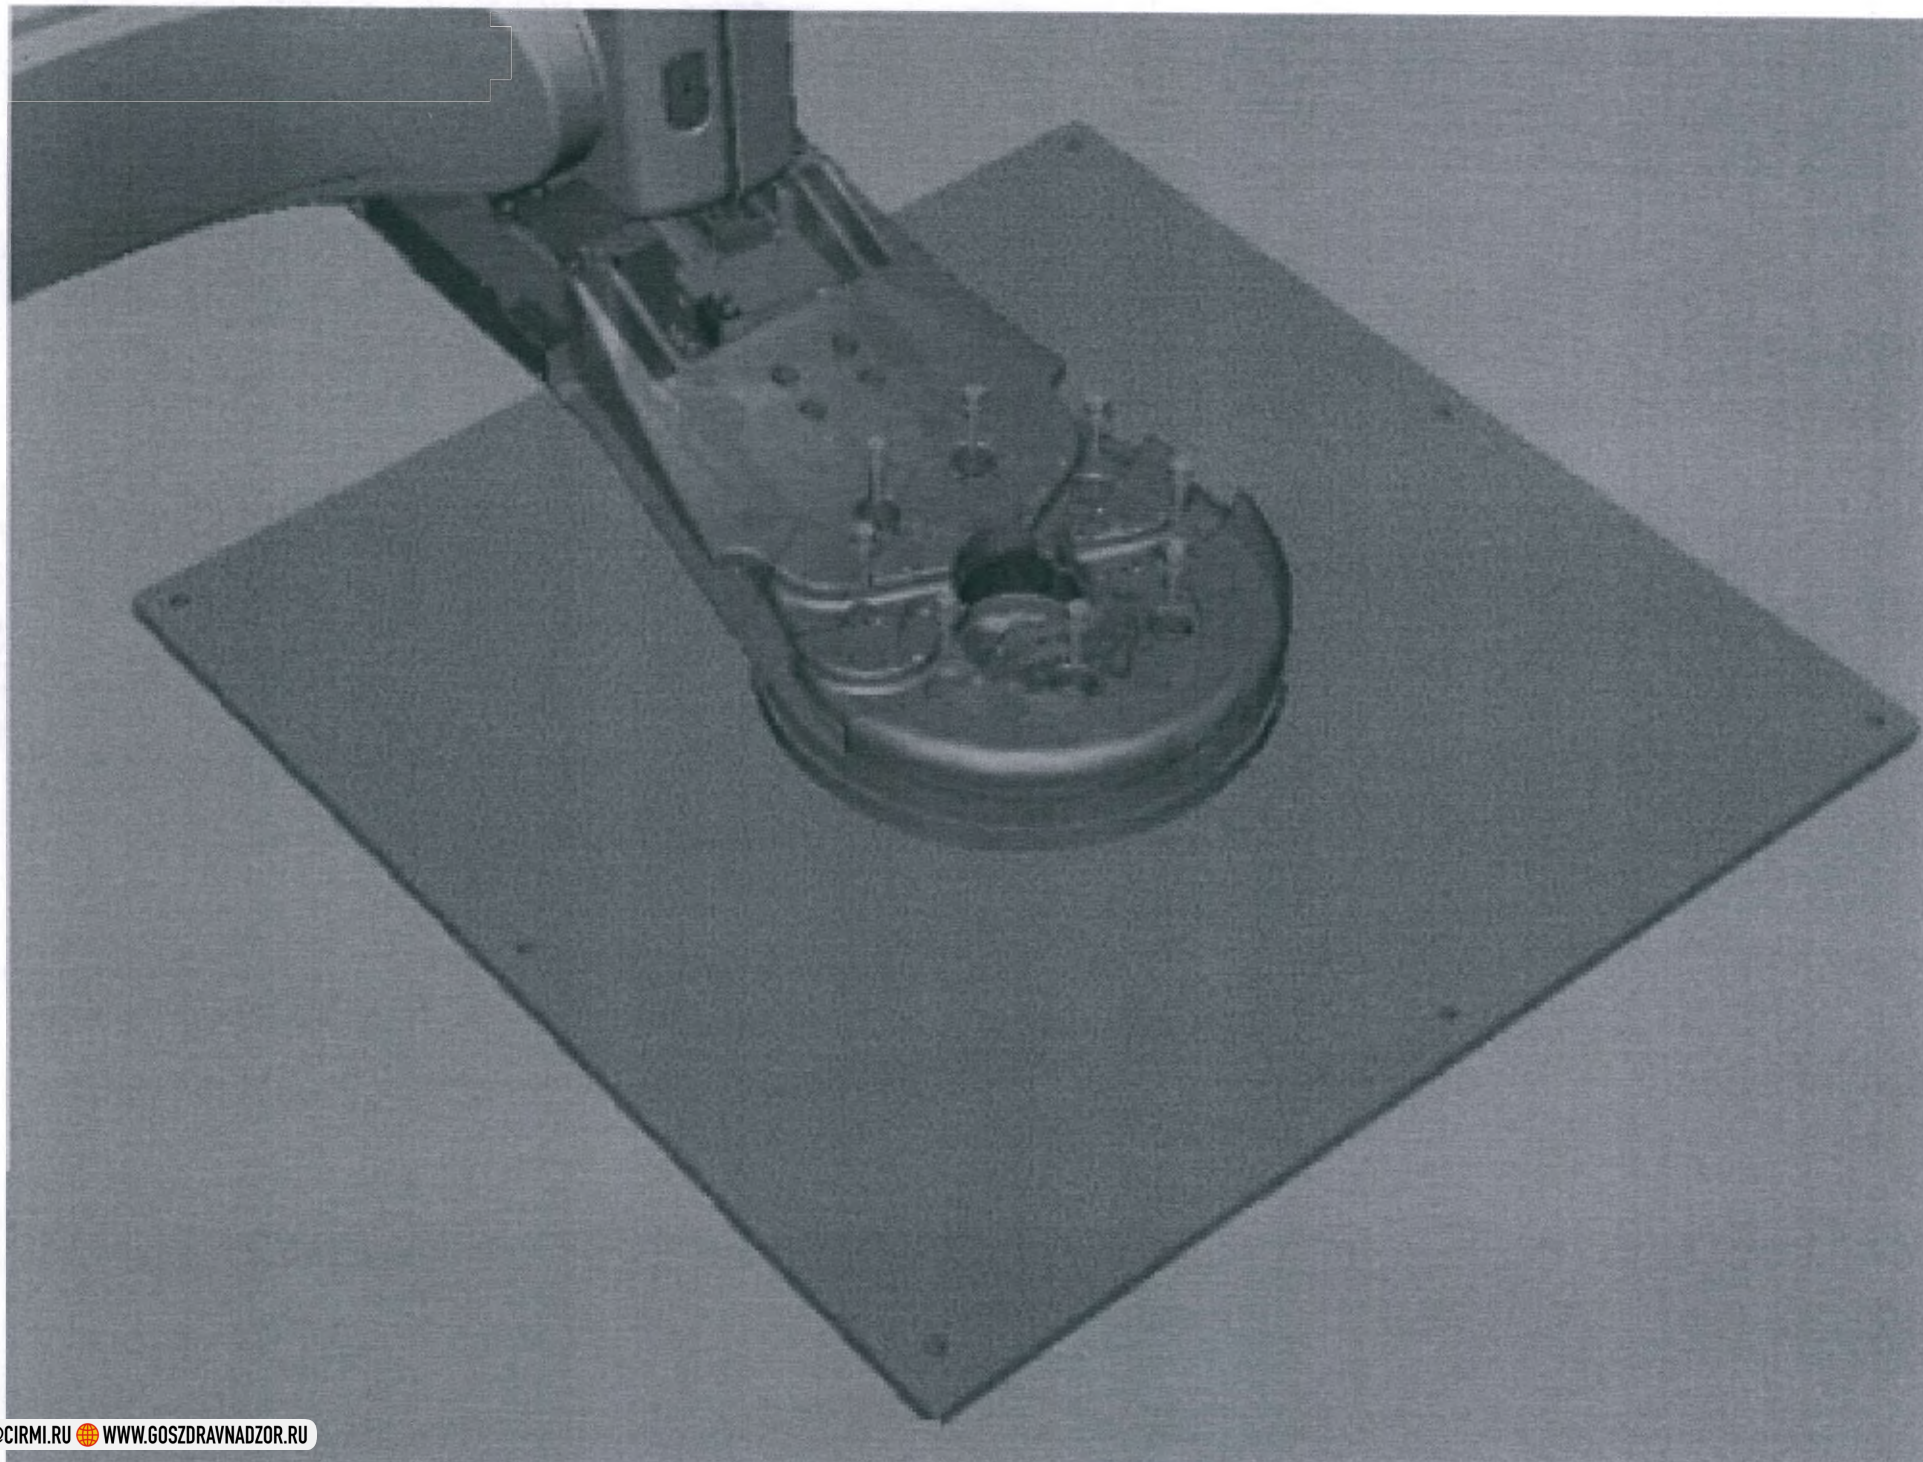

6. Переключатель управления декой стола.





8. Ножной переключатель (дополнительный).

239




9. Беспроводной ножной переключатель.



Беспроводной ножной переключатель




Сетевой адаптер

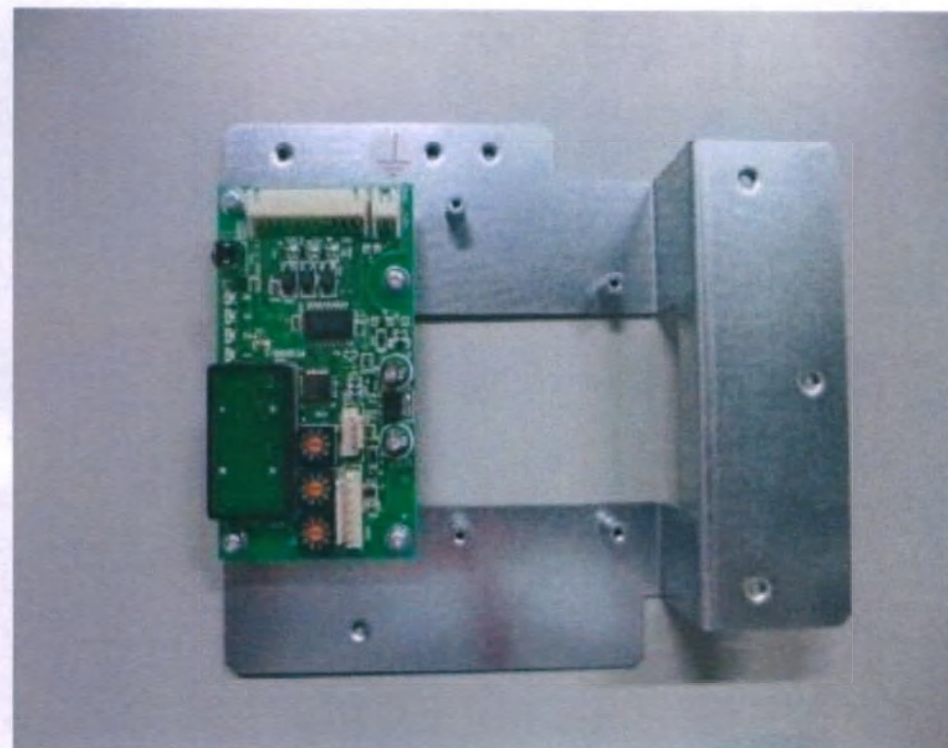



Приемник сигнала


10. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-850В).

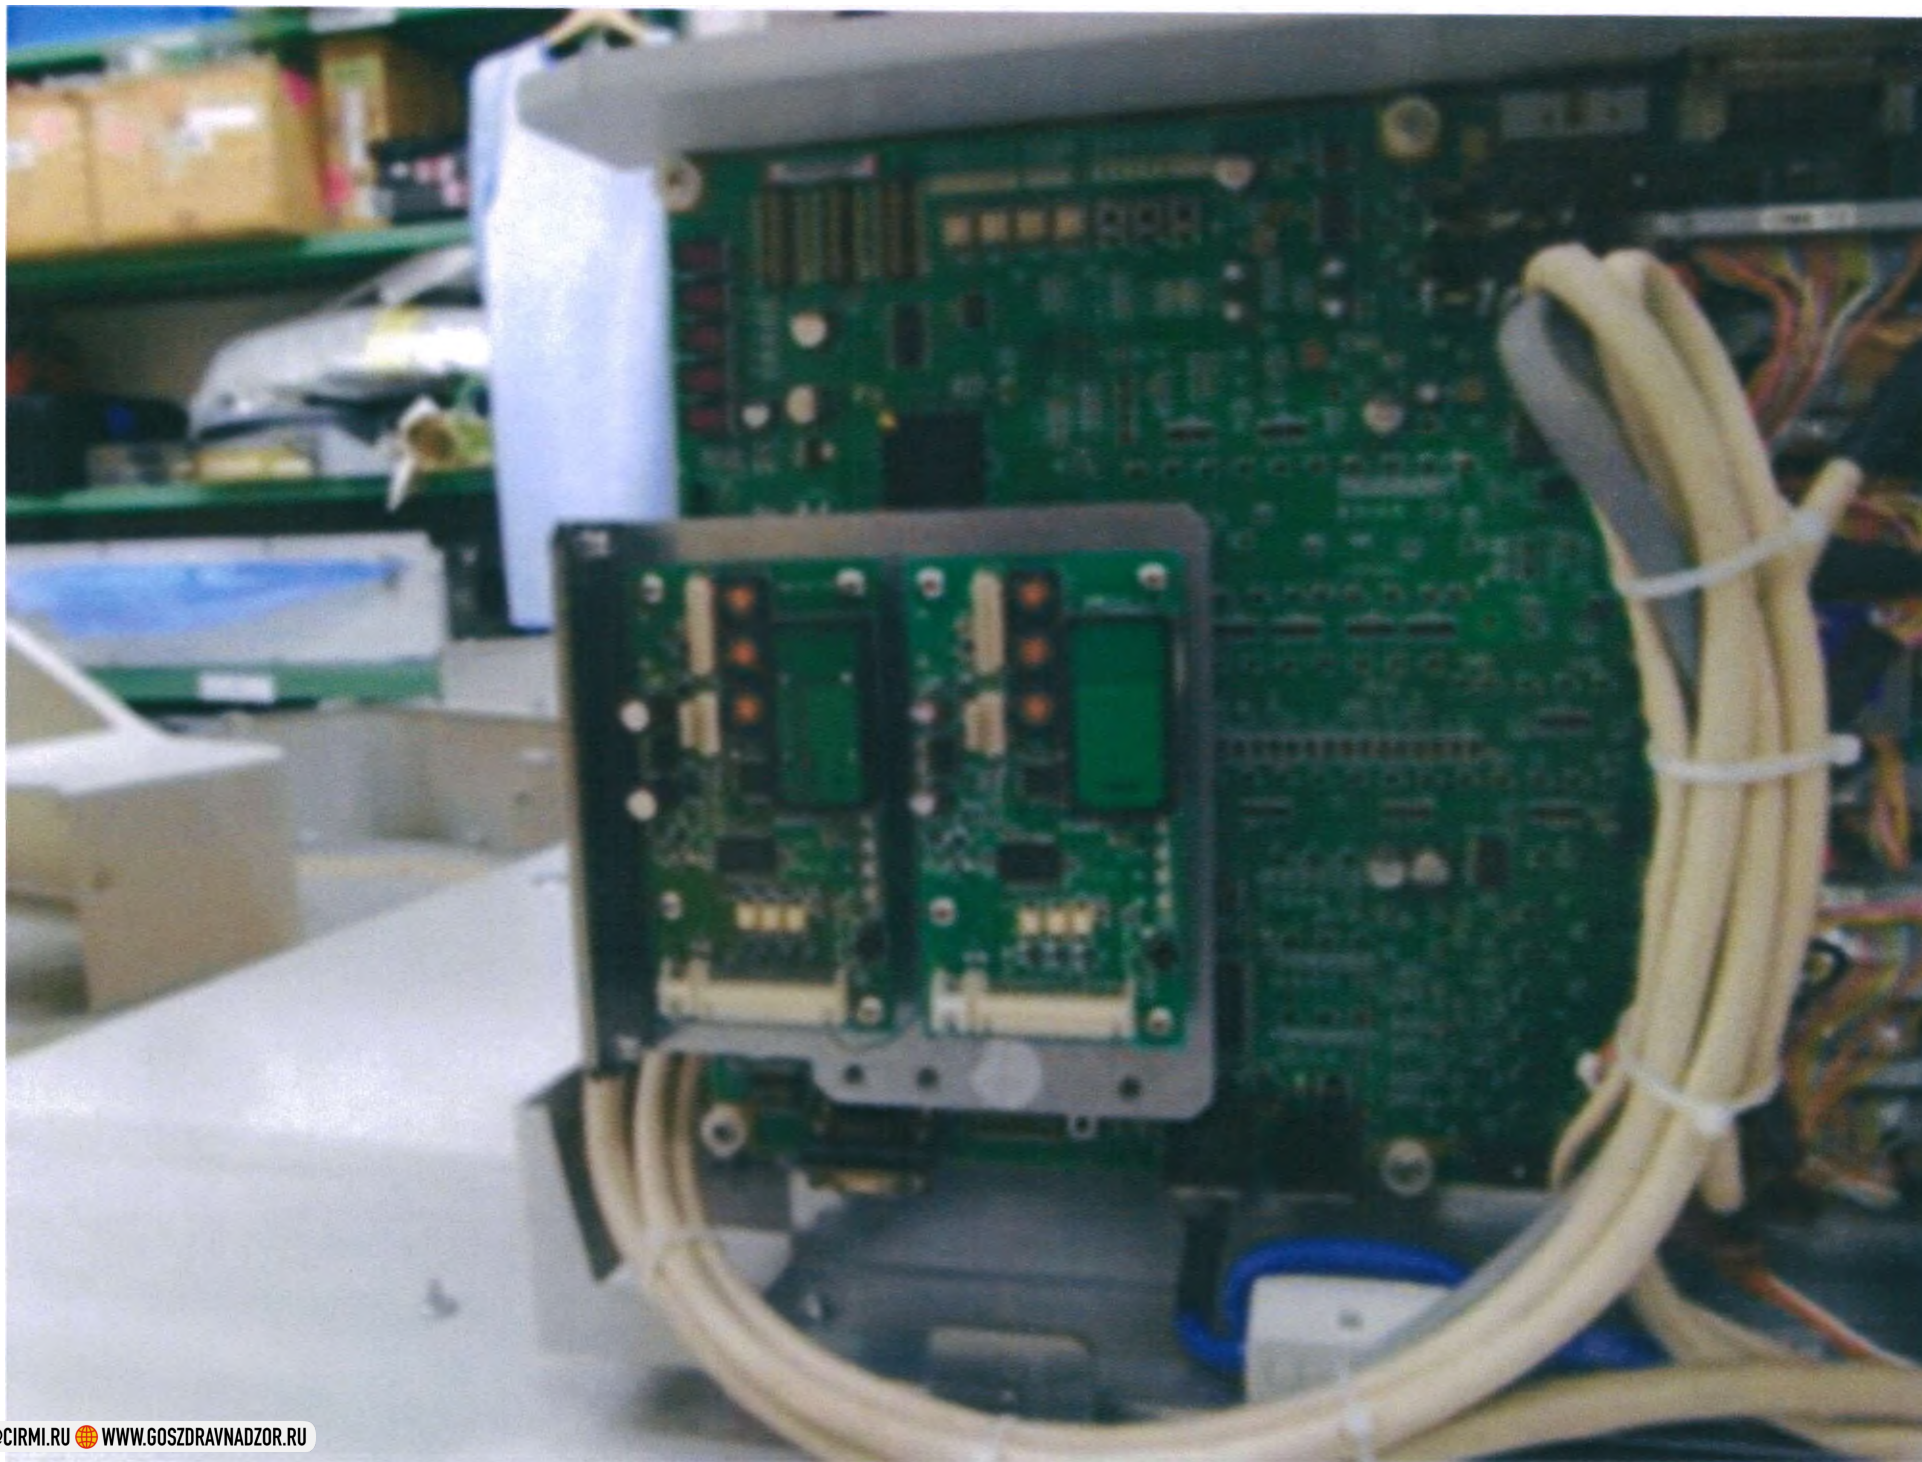


11. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-880В).

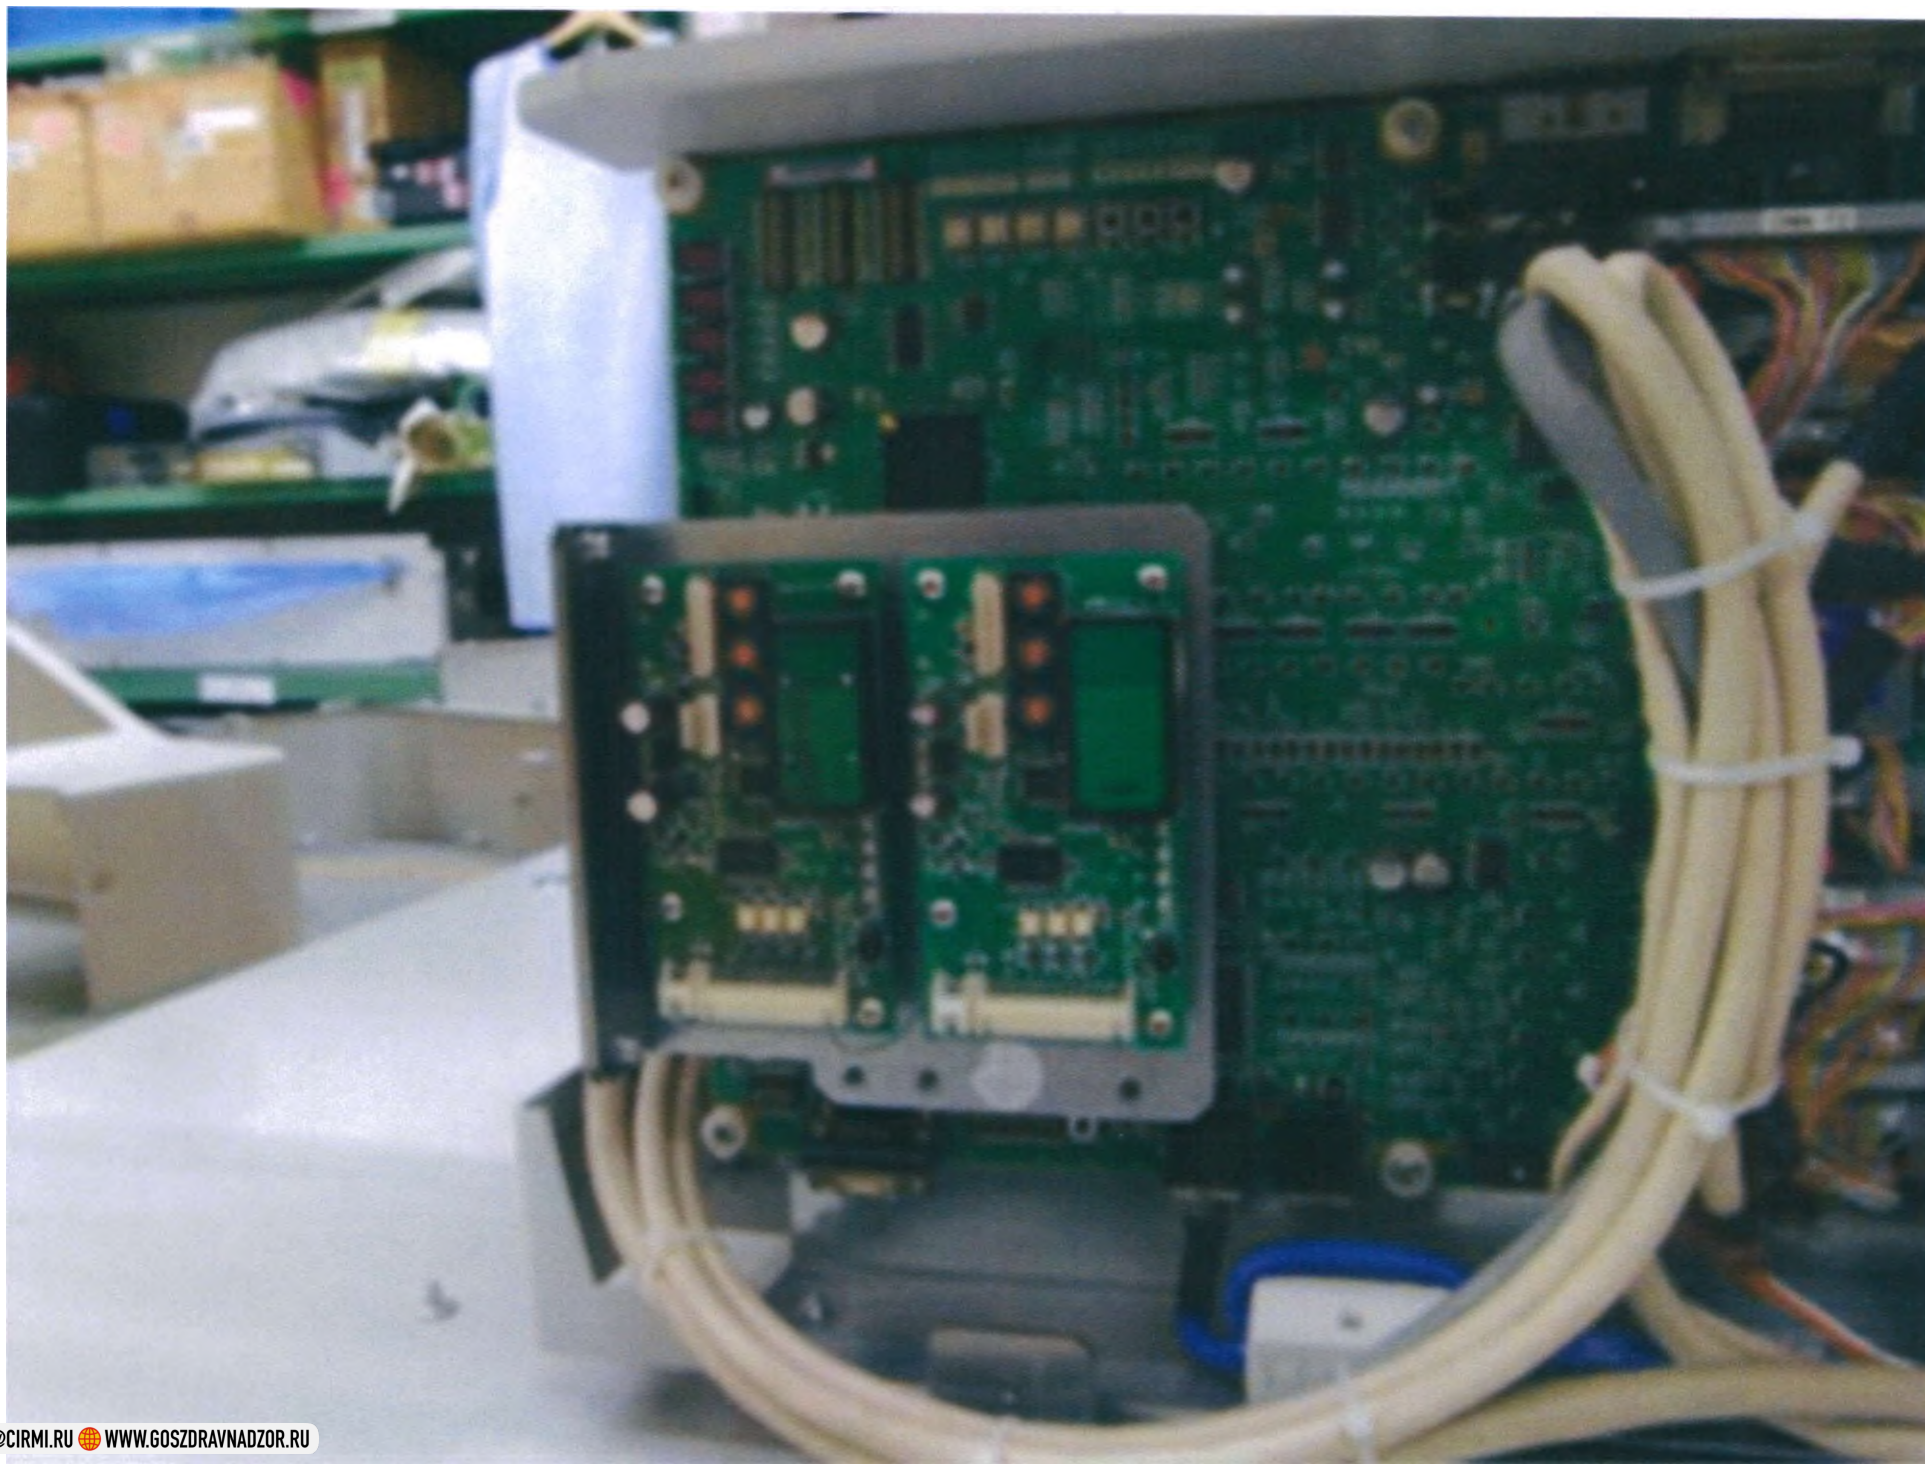

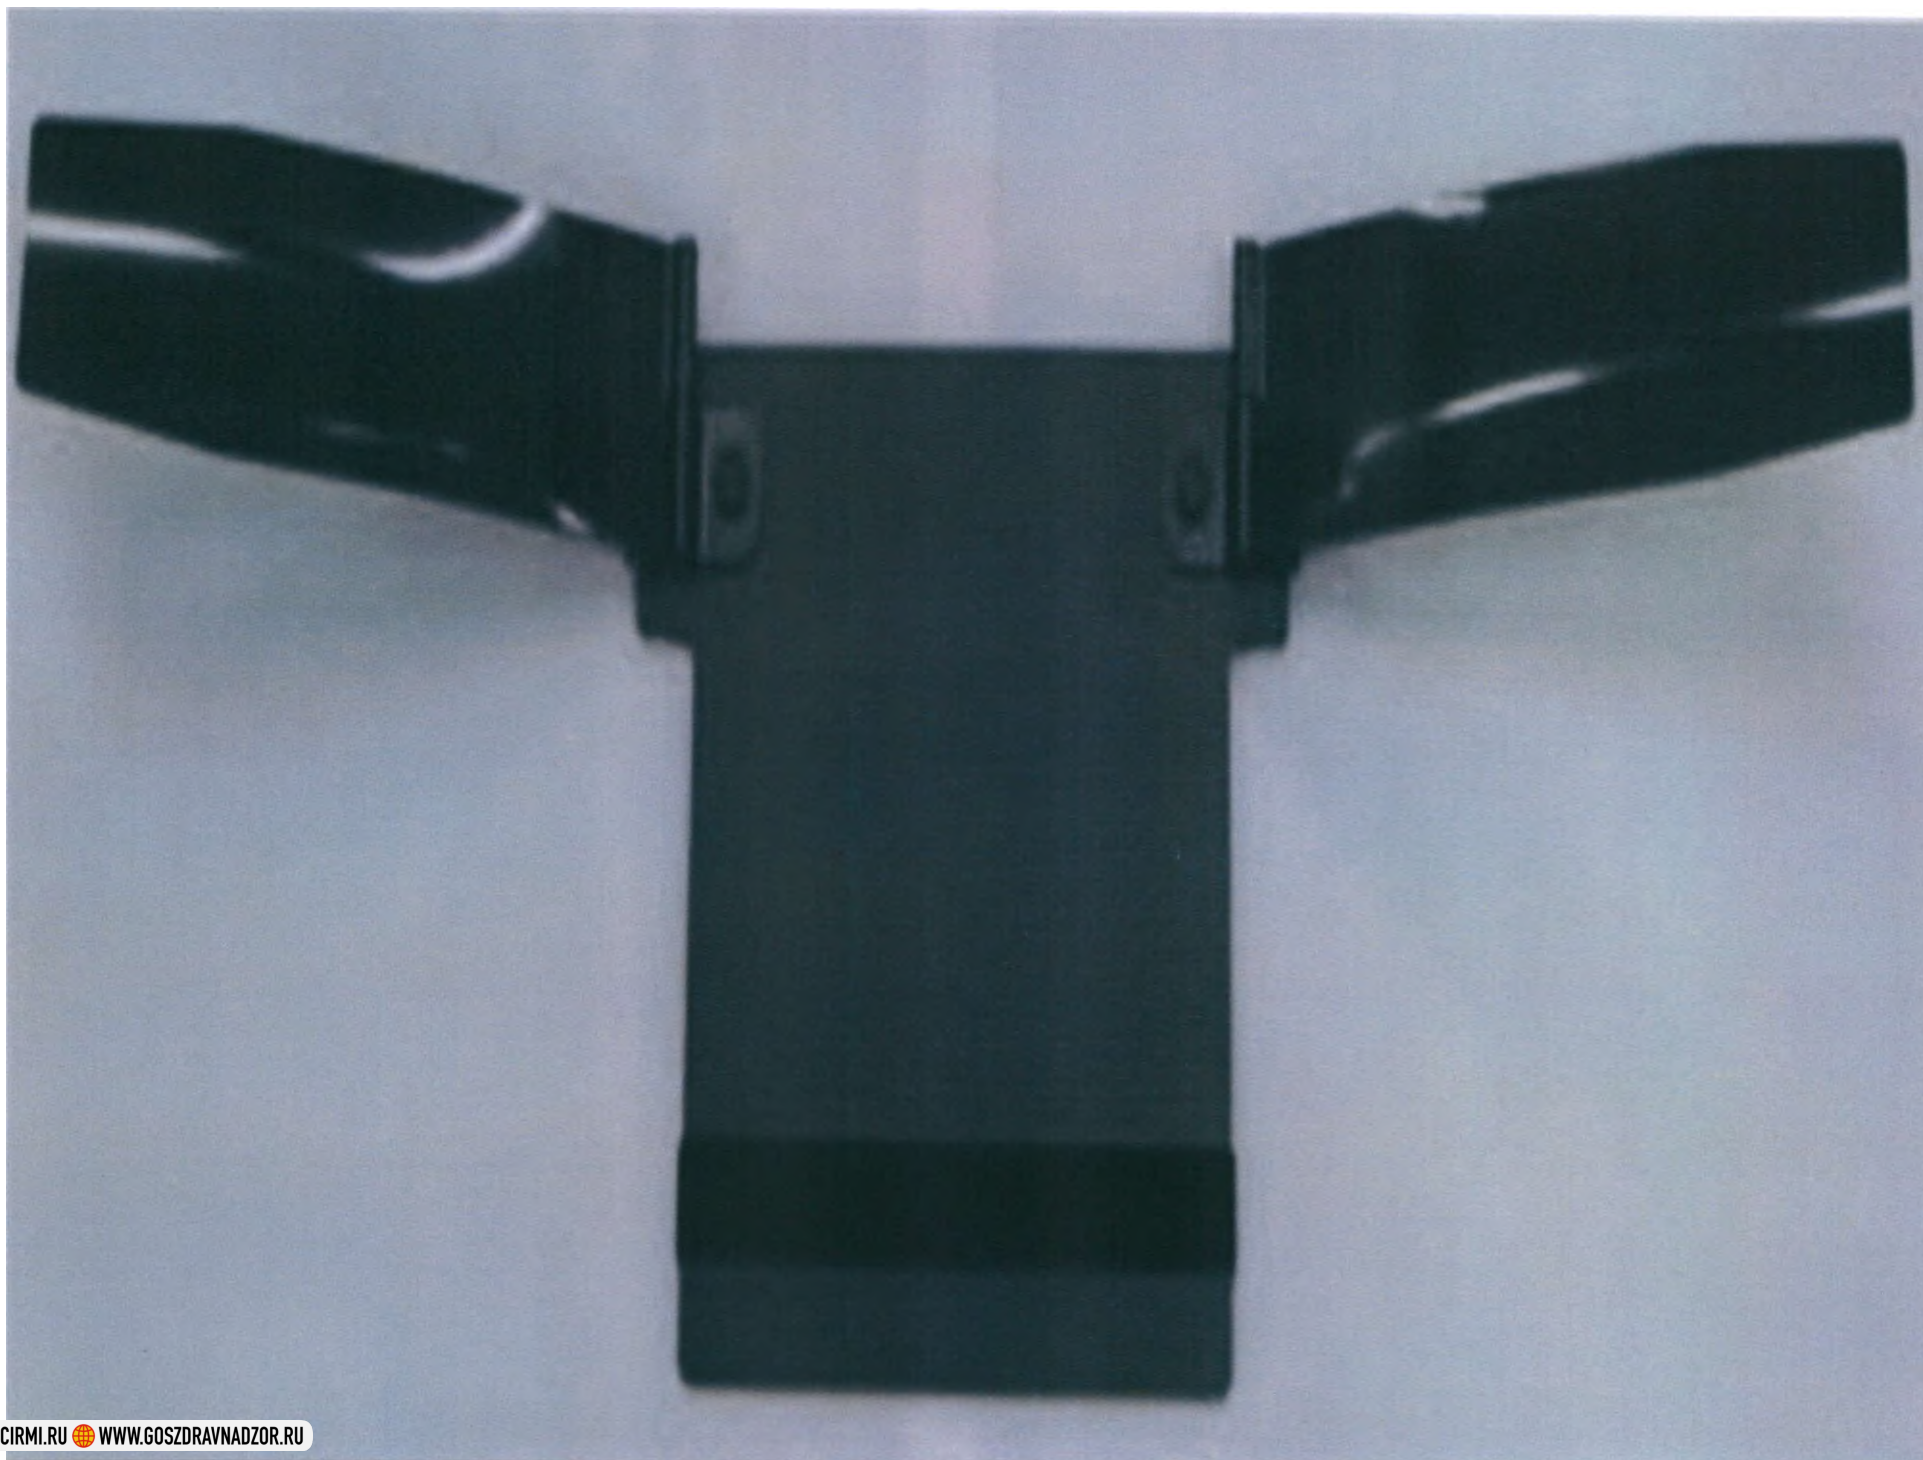

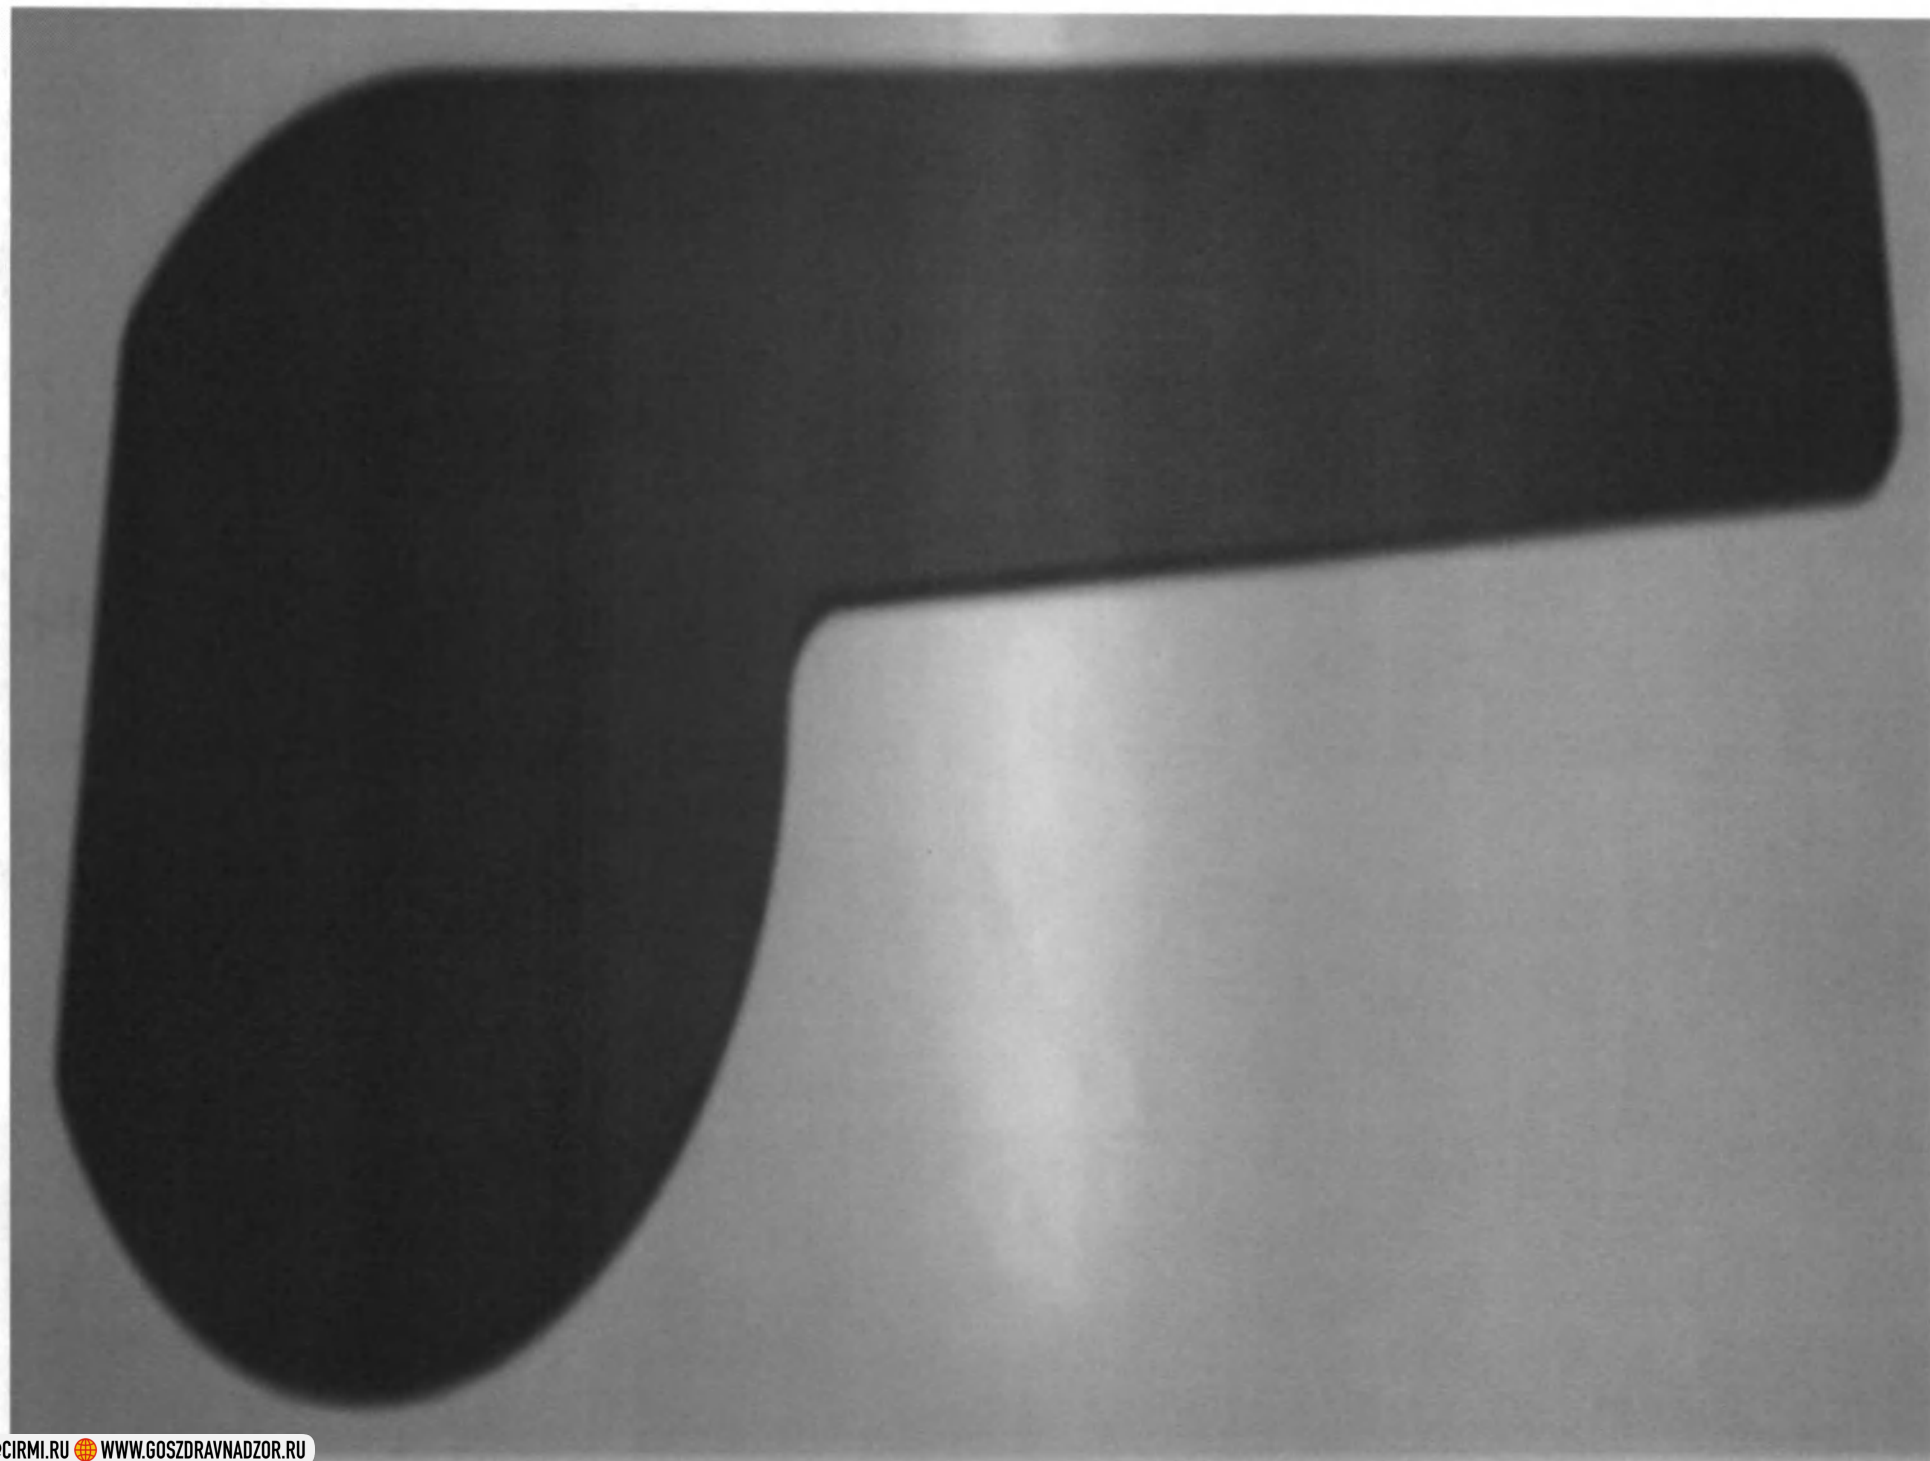





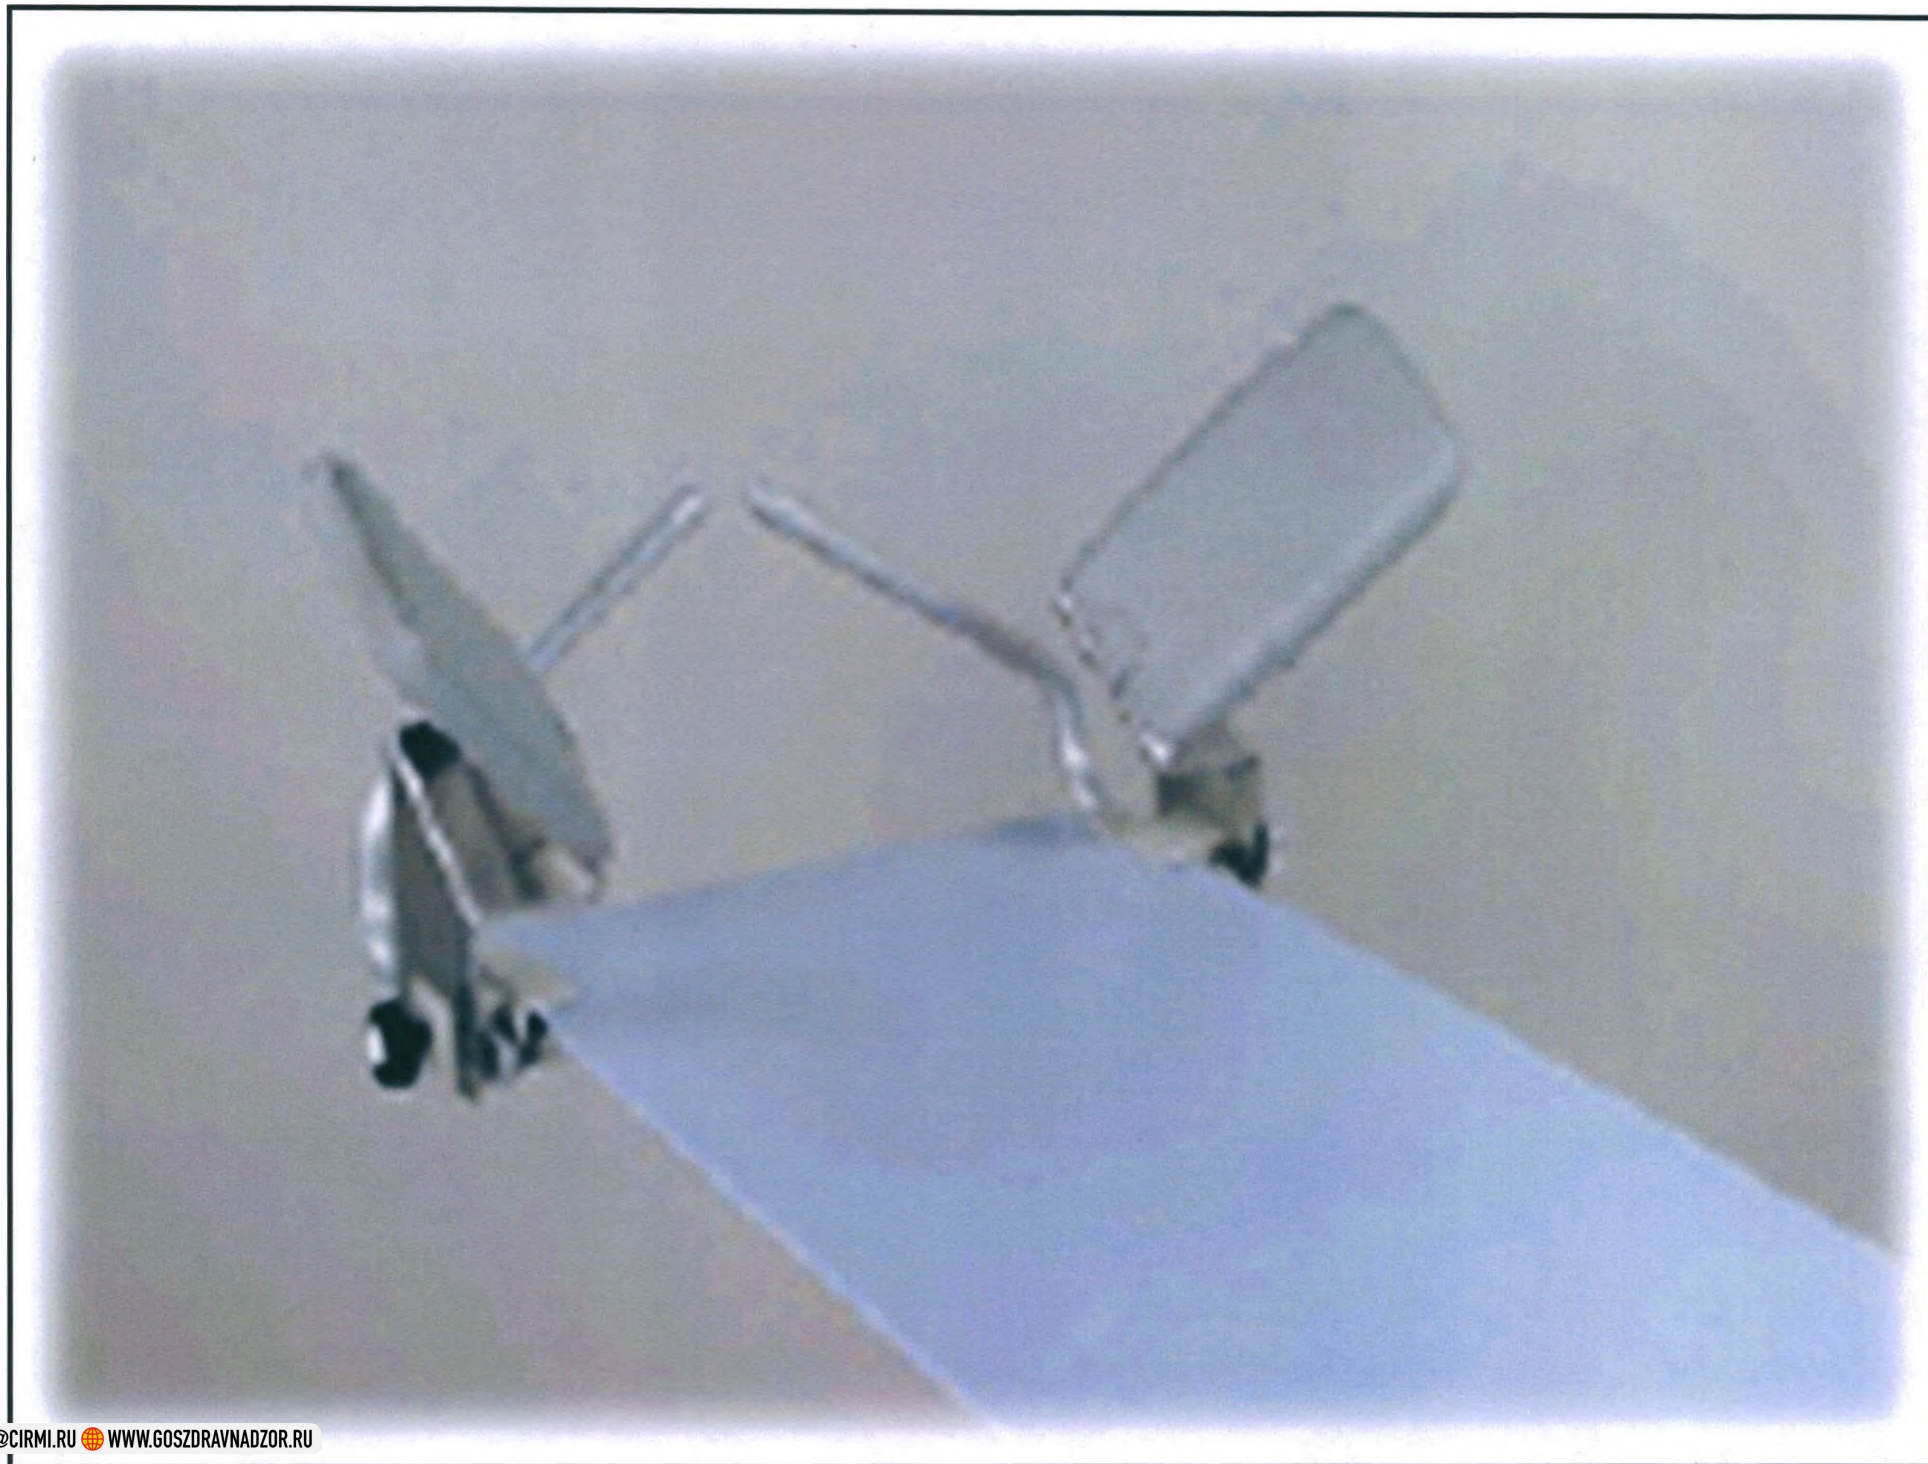


16. Нарукавник (панель для защиты рук).




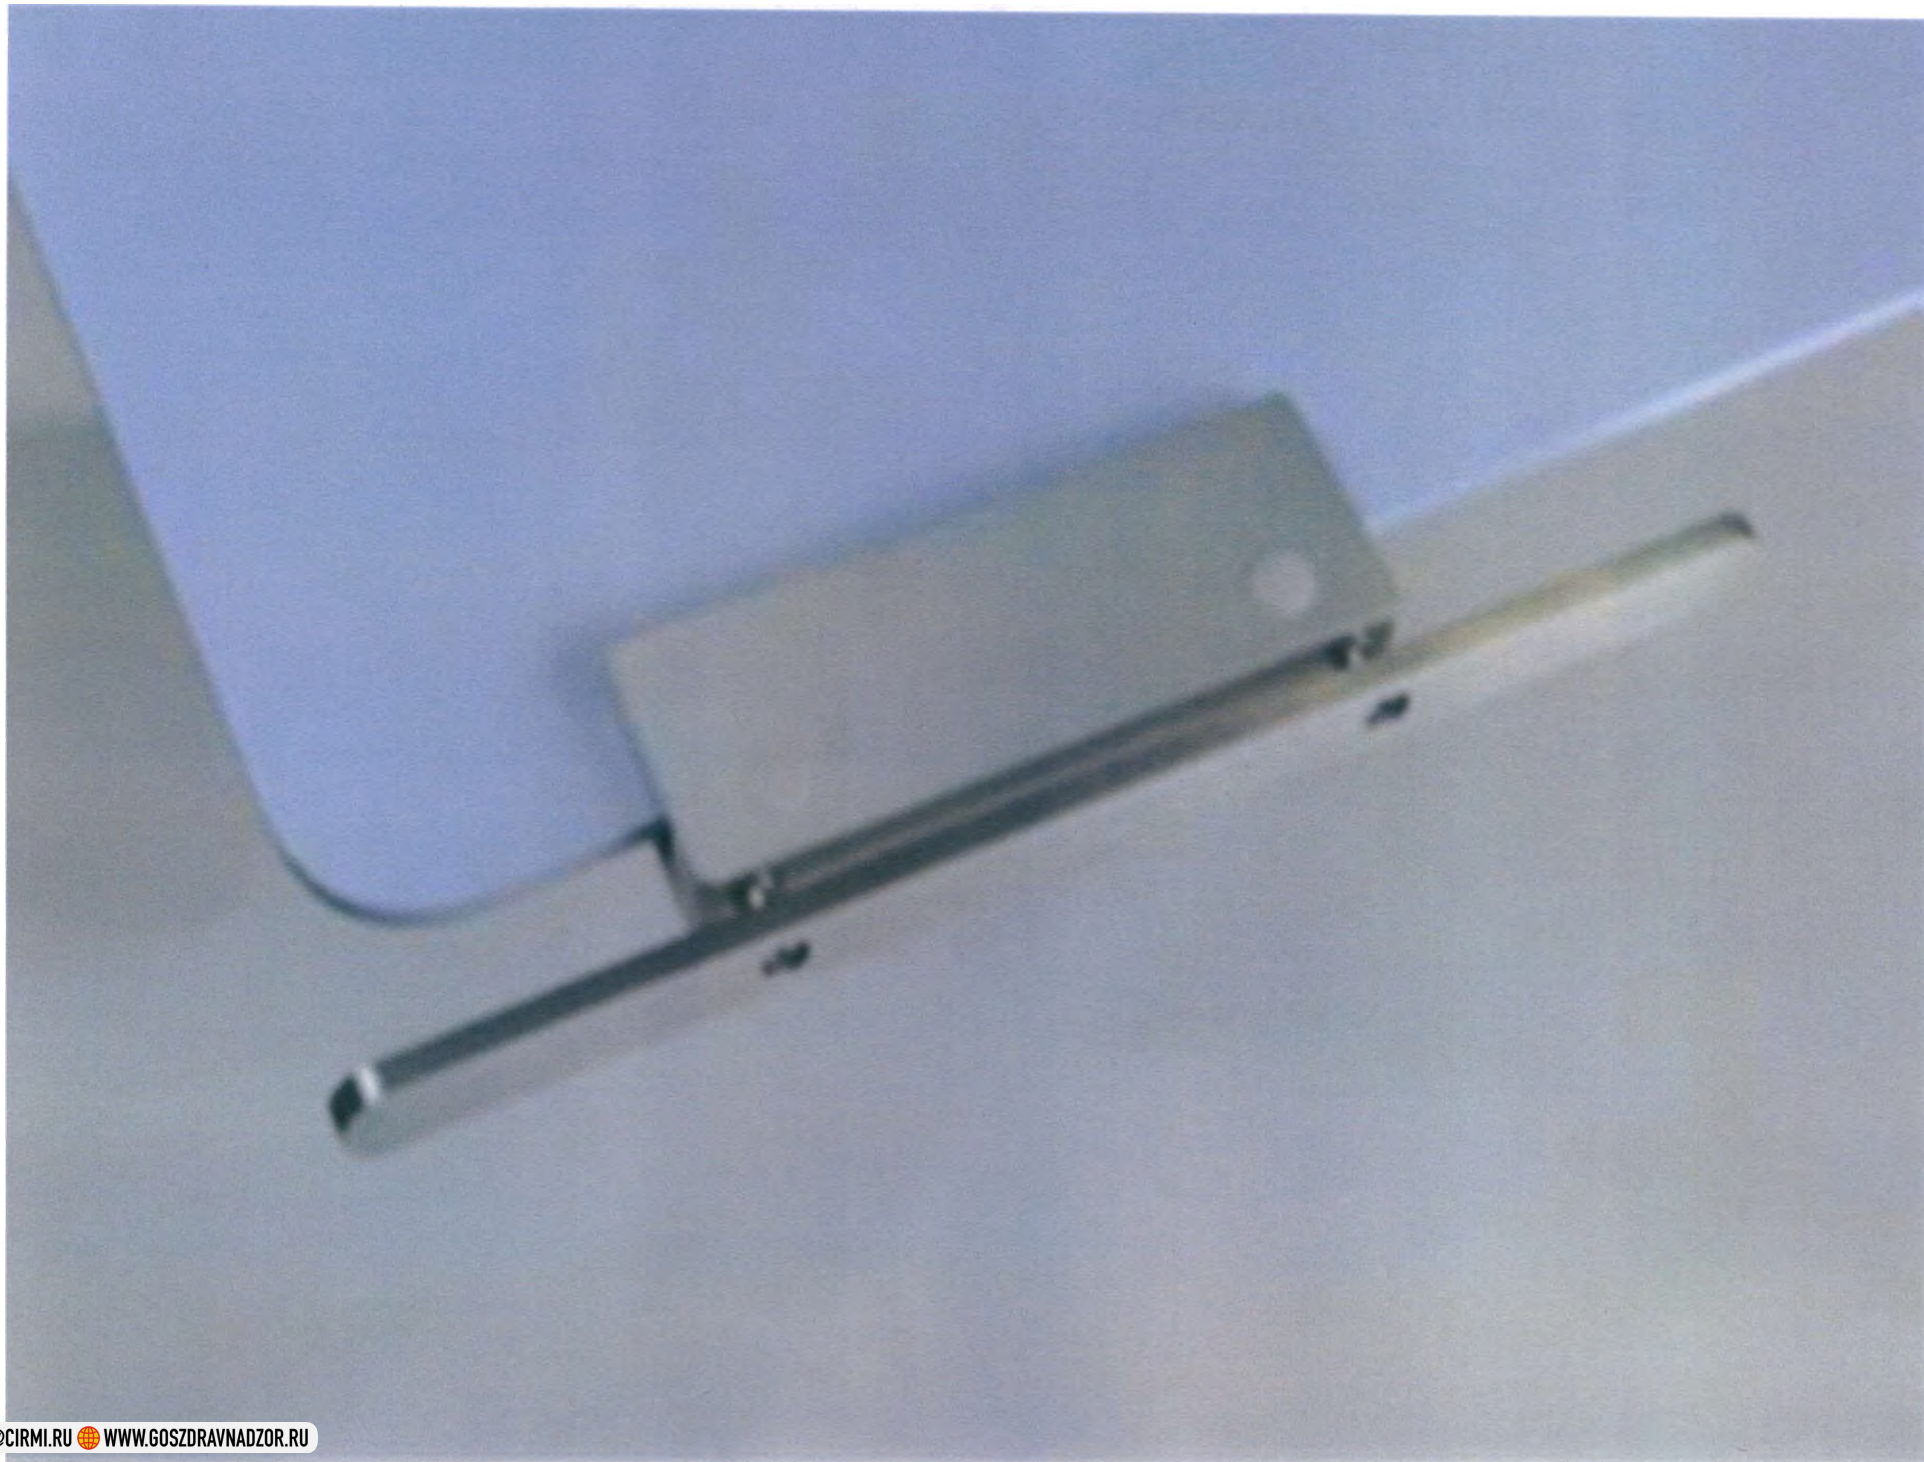

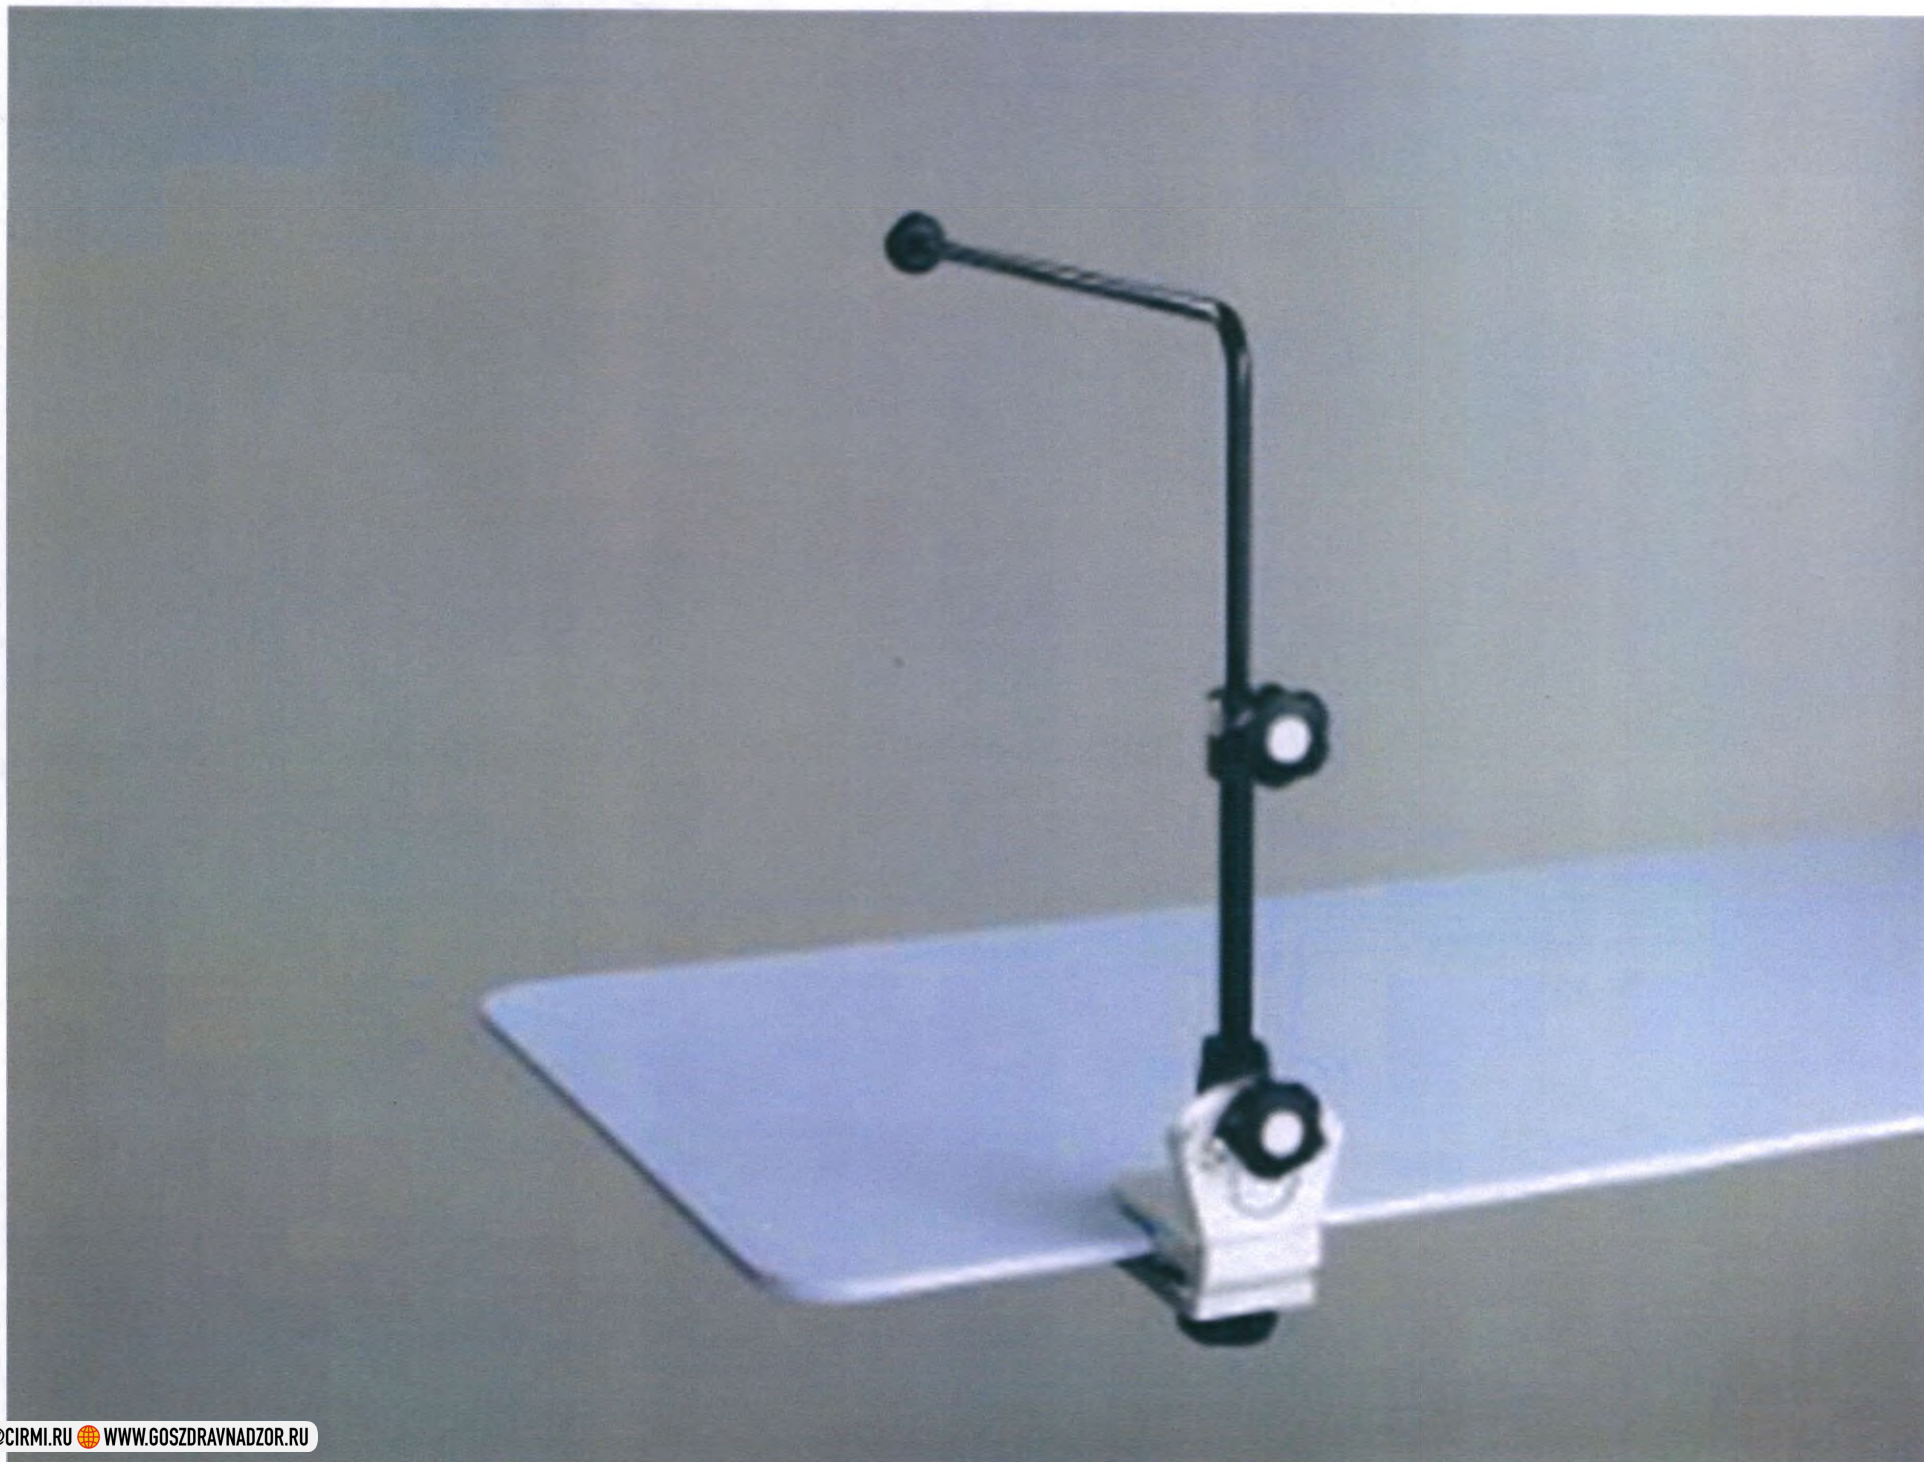

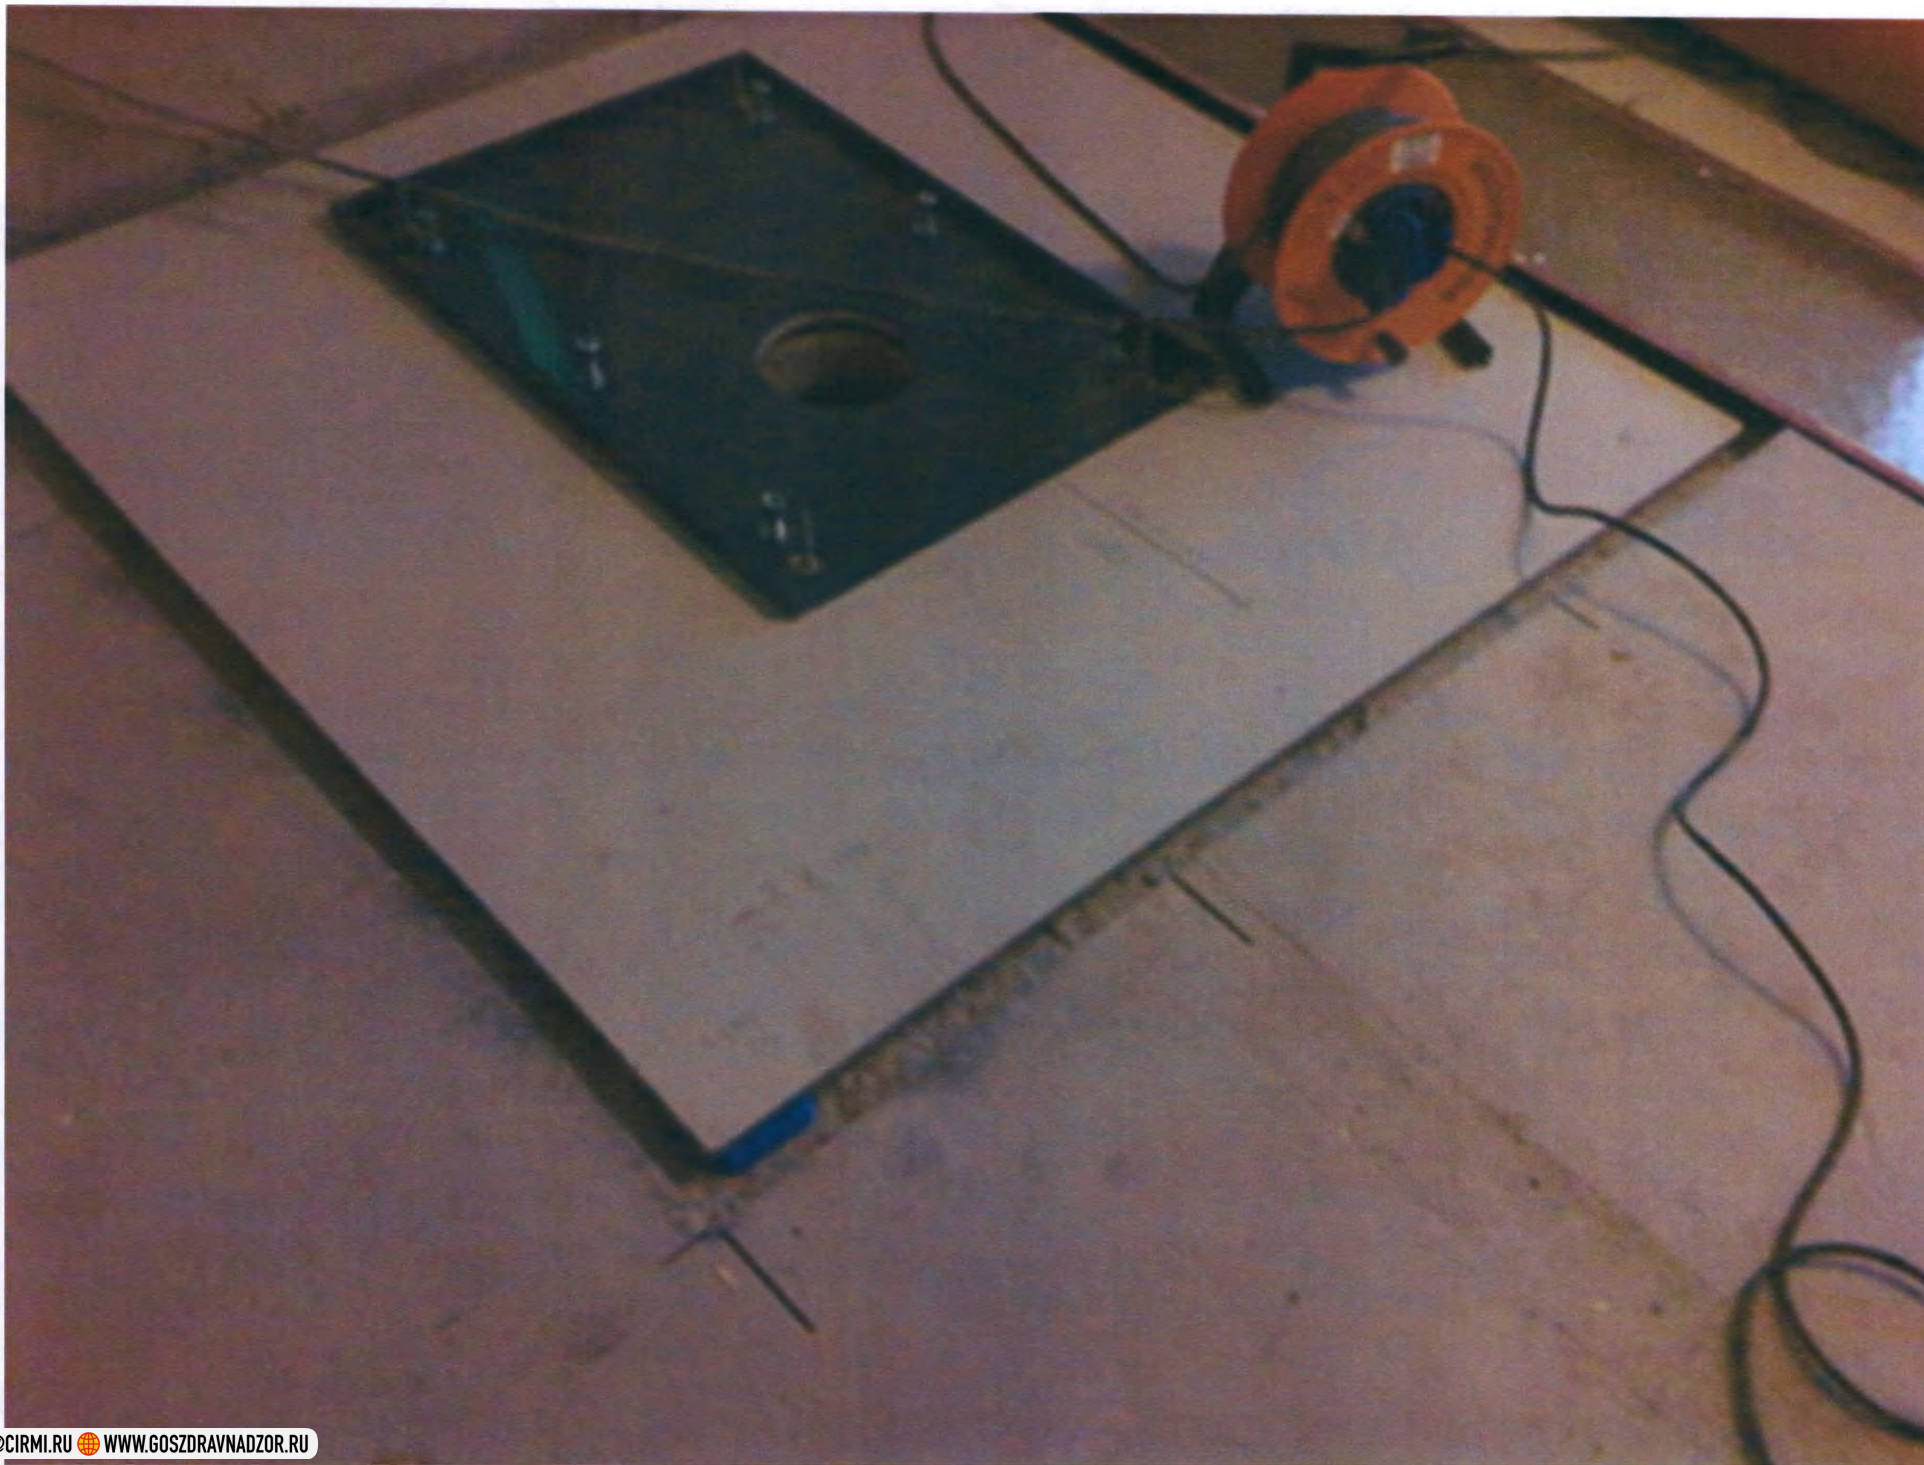

20. Выдвижные направляющие для стола.

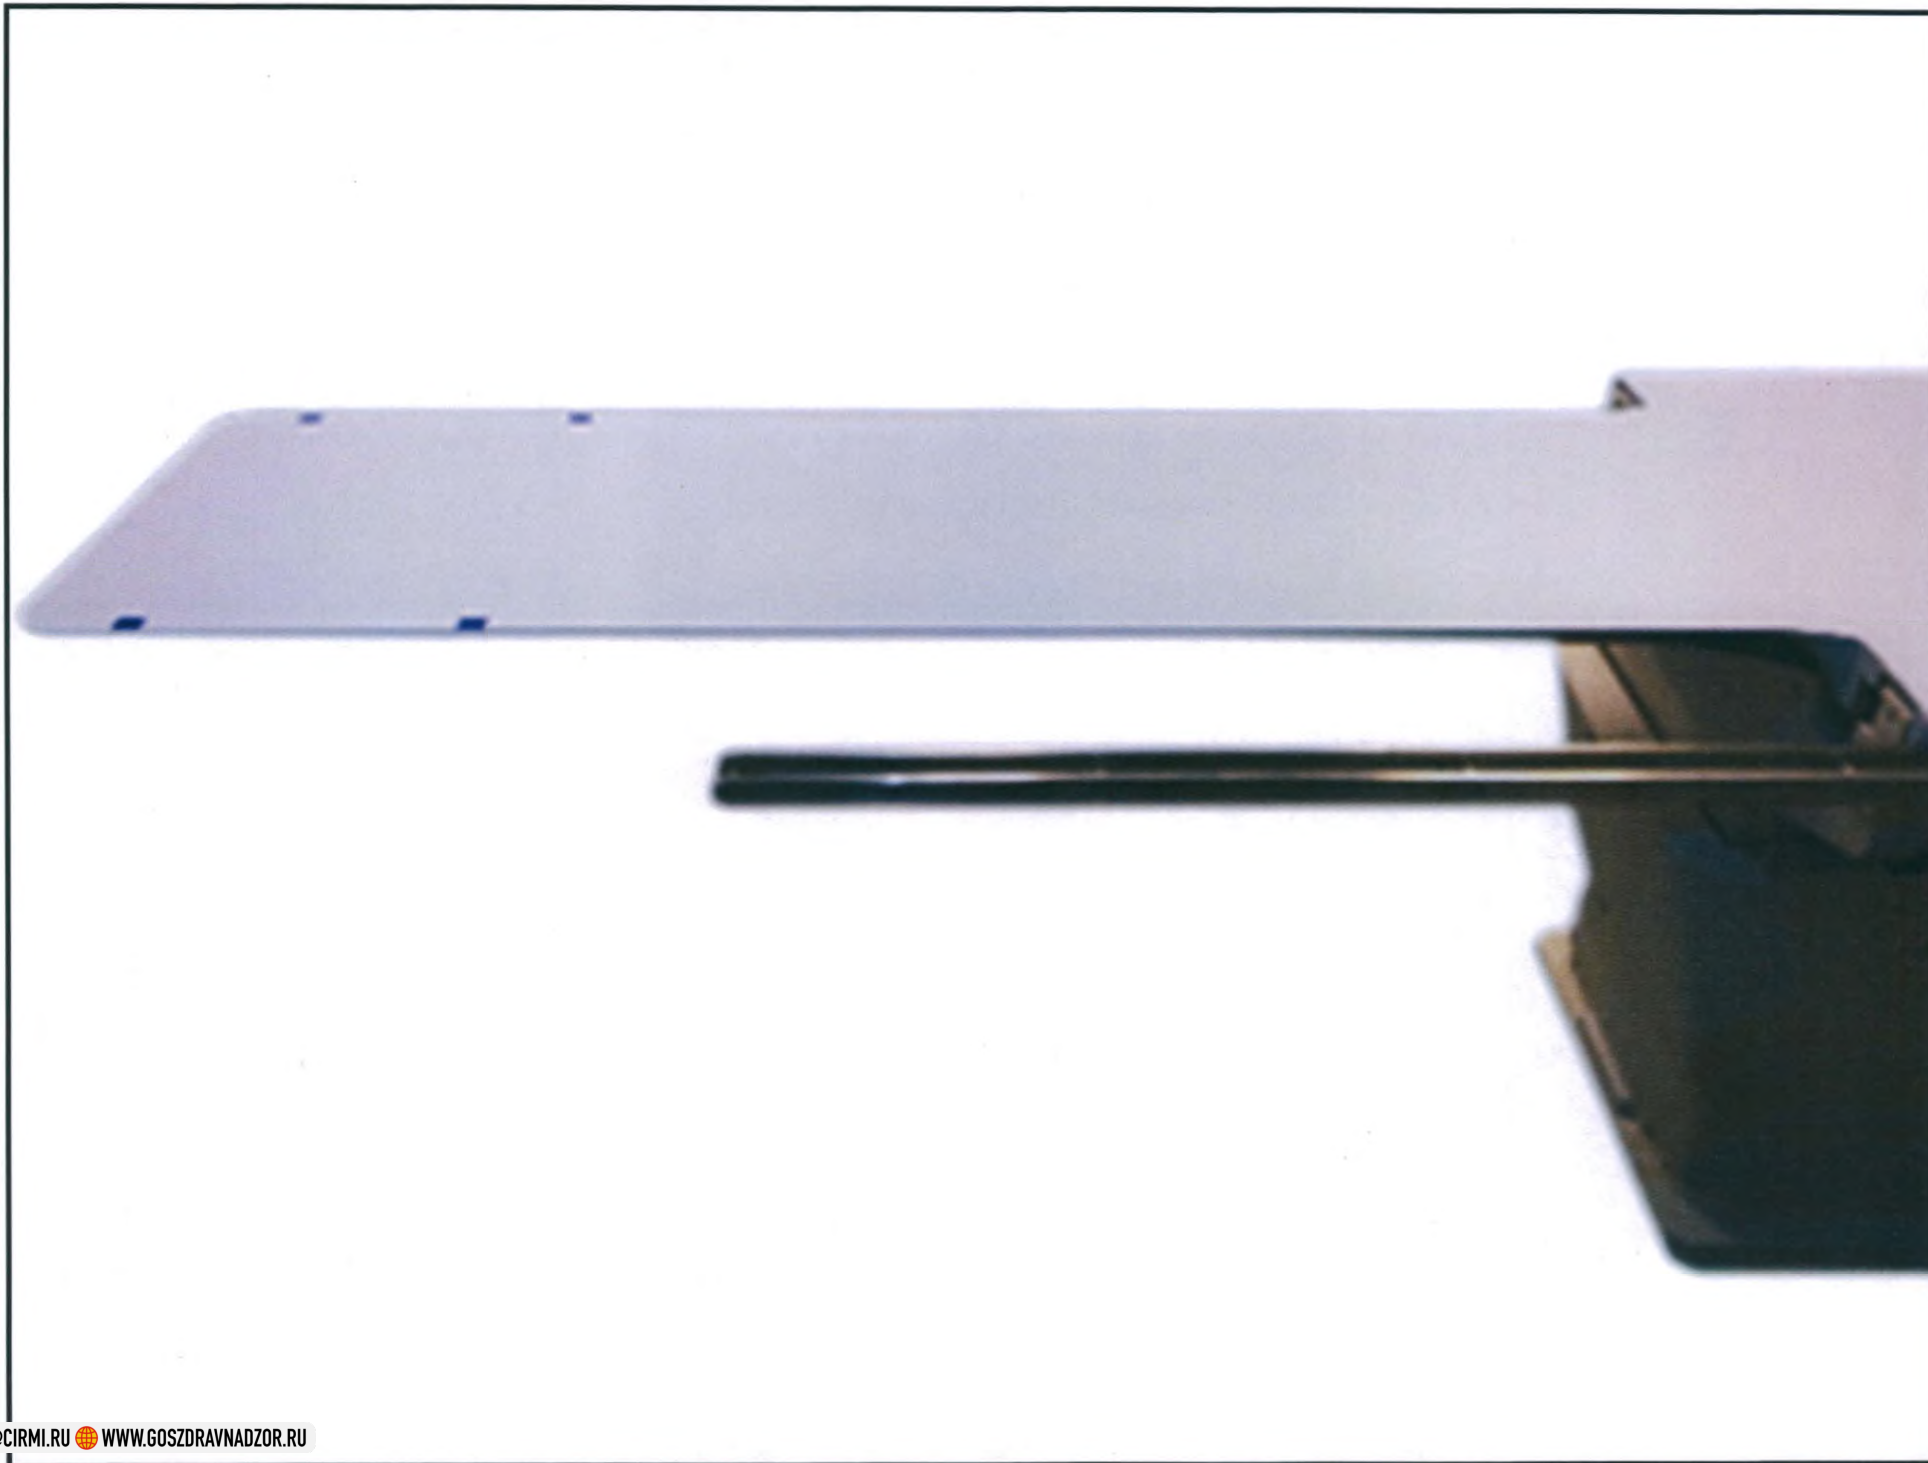




22. Комплект управляющего переключателя стола на головном конце (для САТ-850В).




23. Накладка для деки стола толщиной 5 см (для САТ-850В).






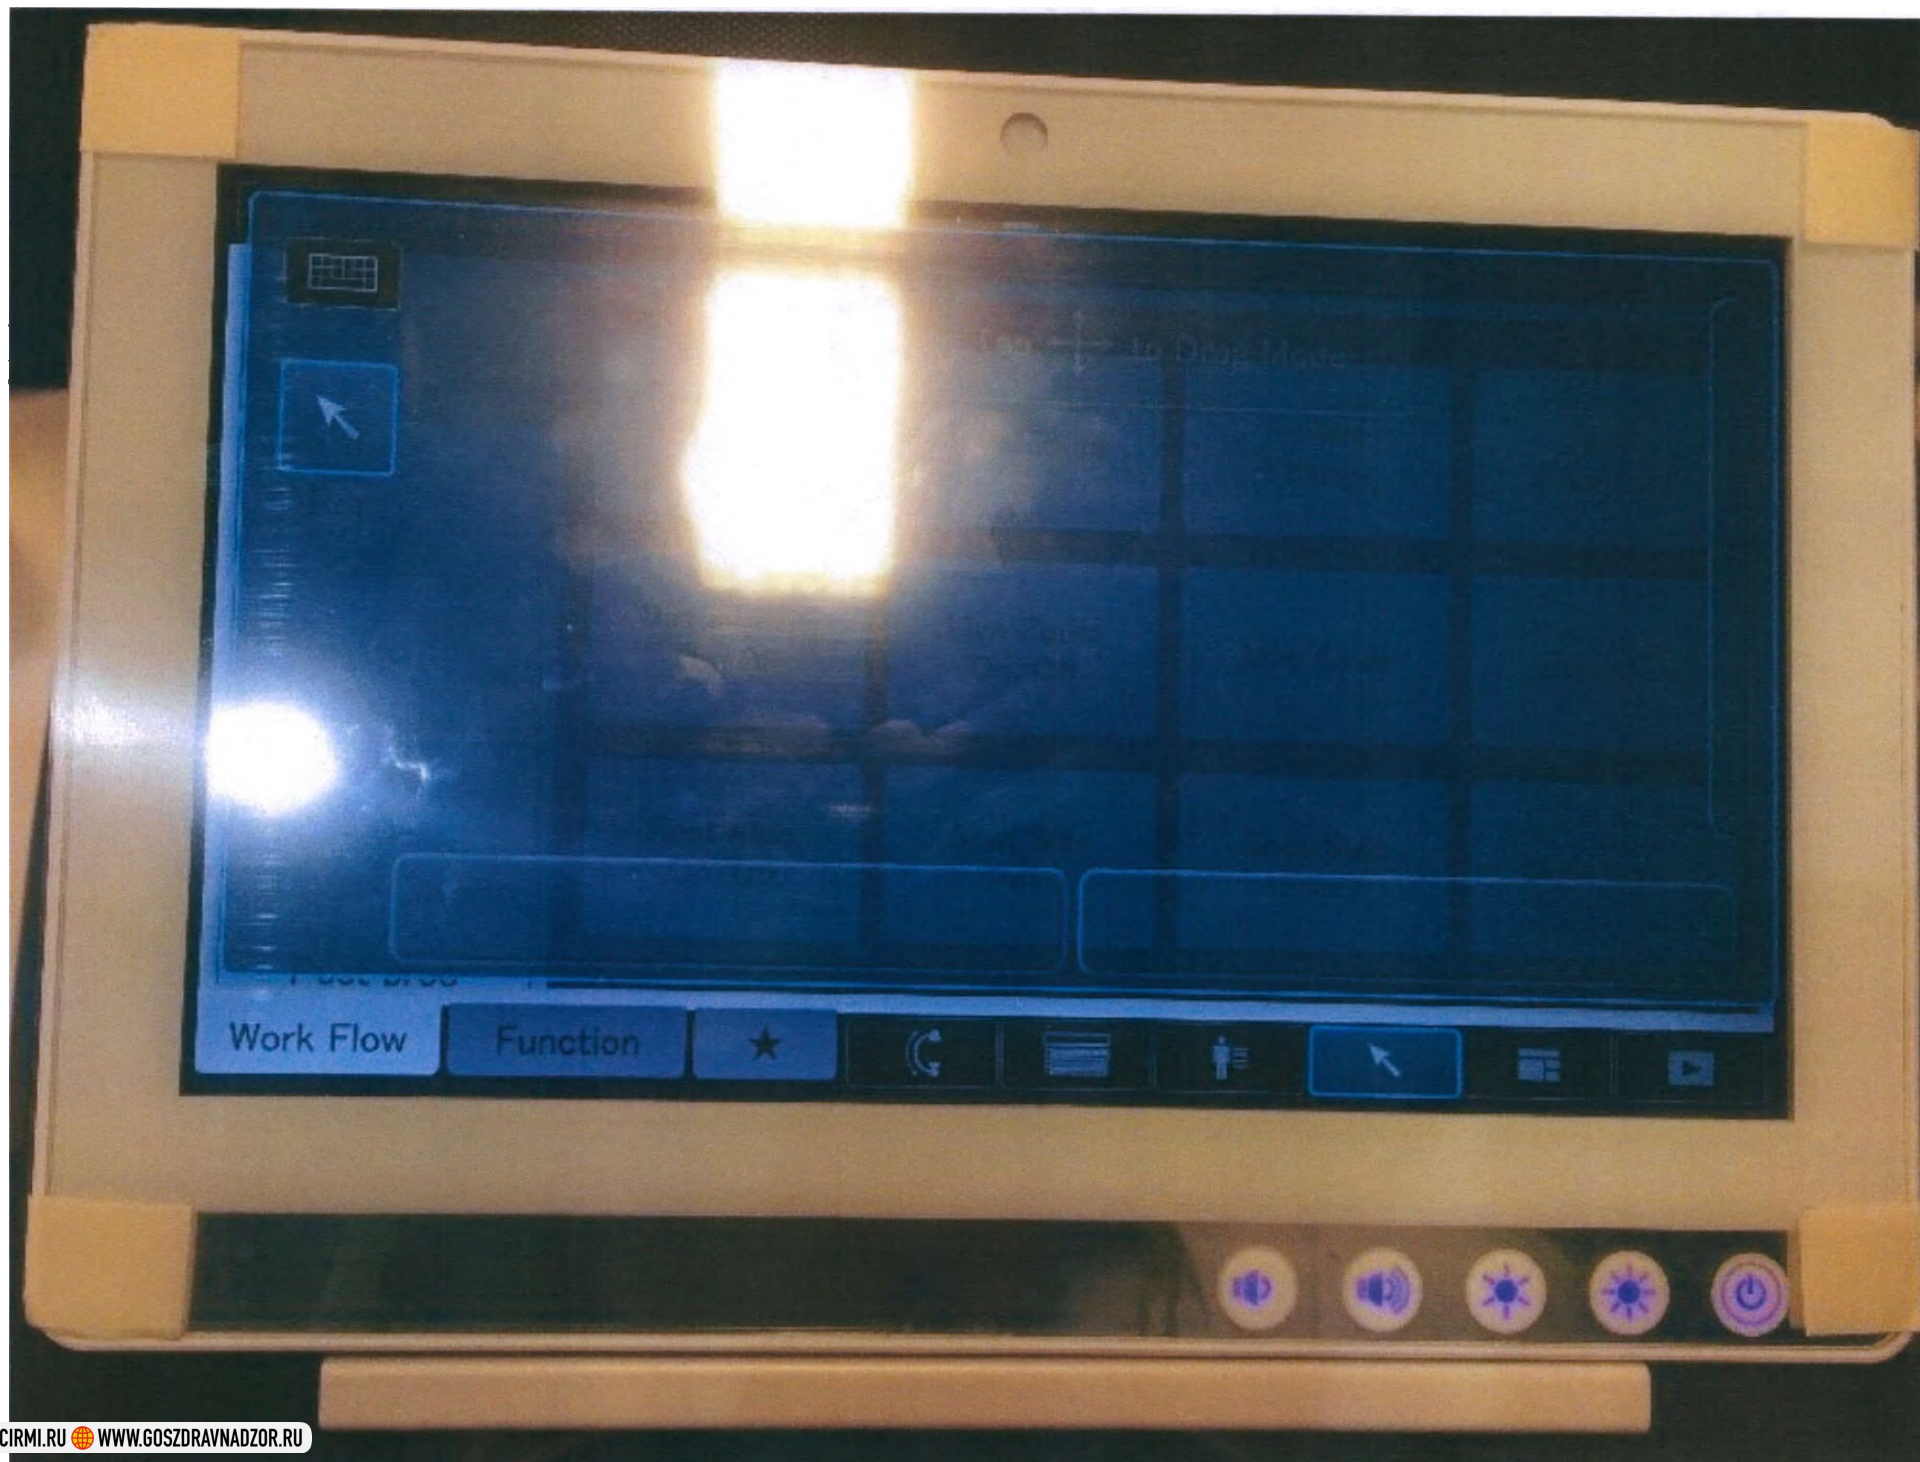


25. Вспомогательная планшетная консоль (Подставка для планшетной консоли).

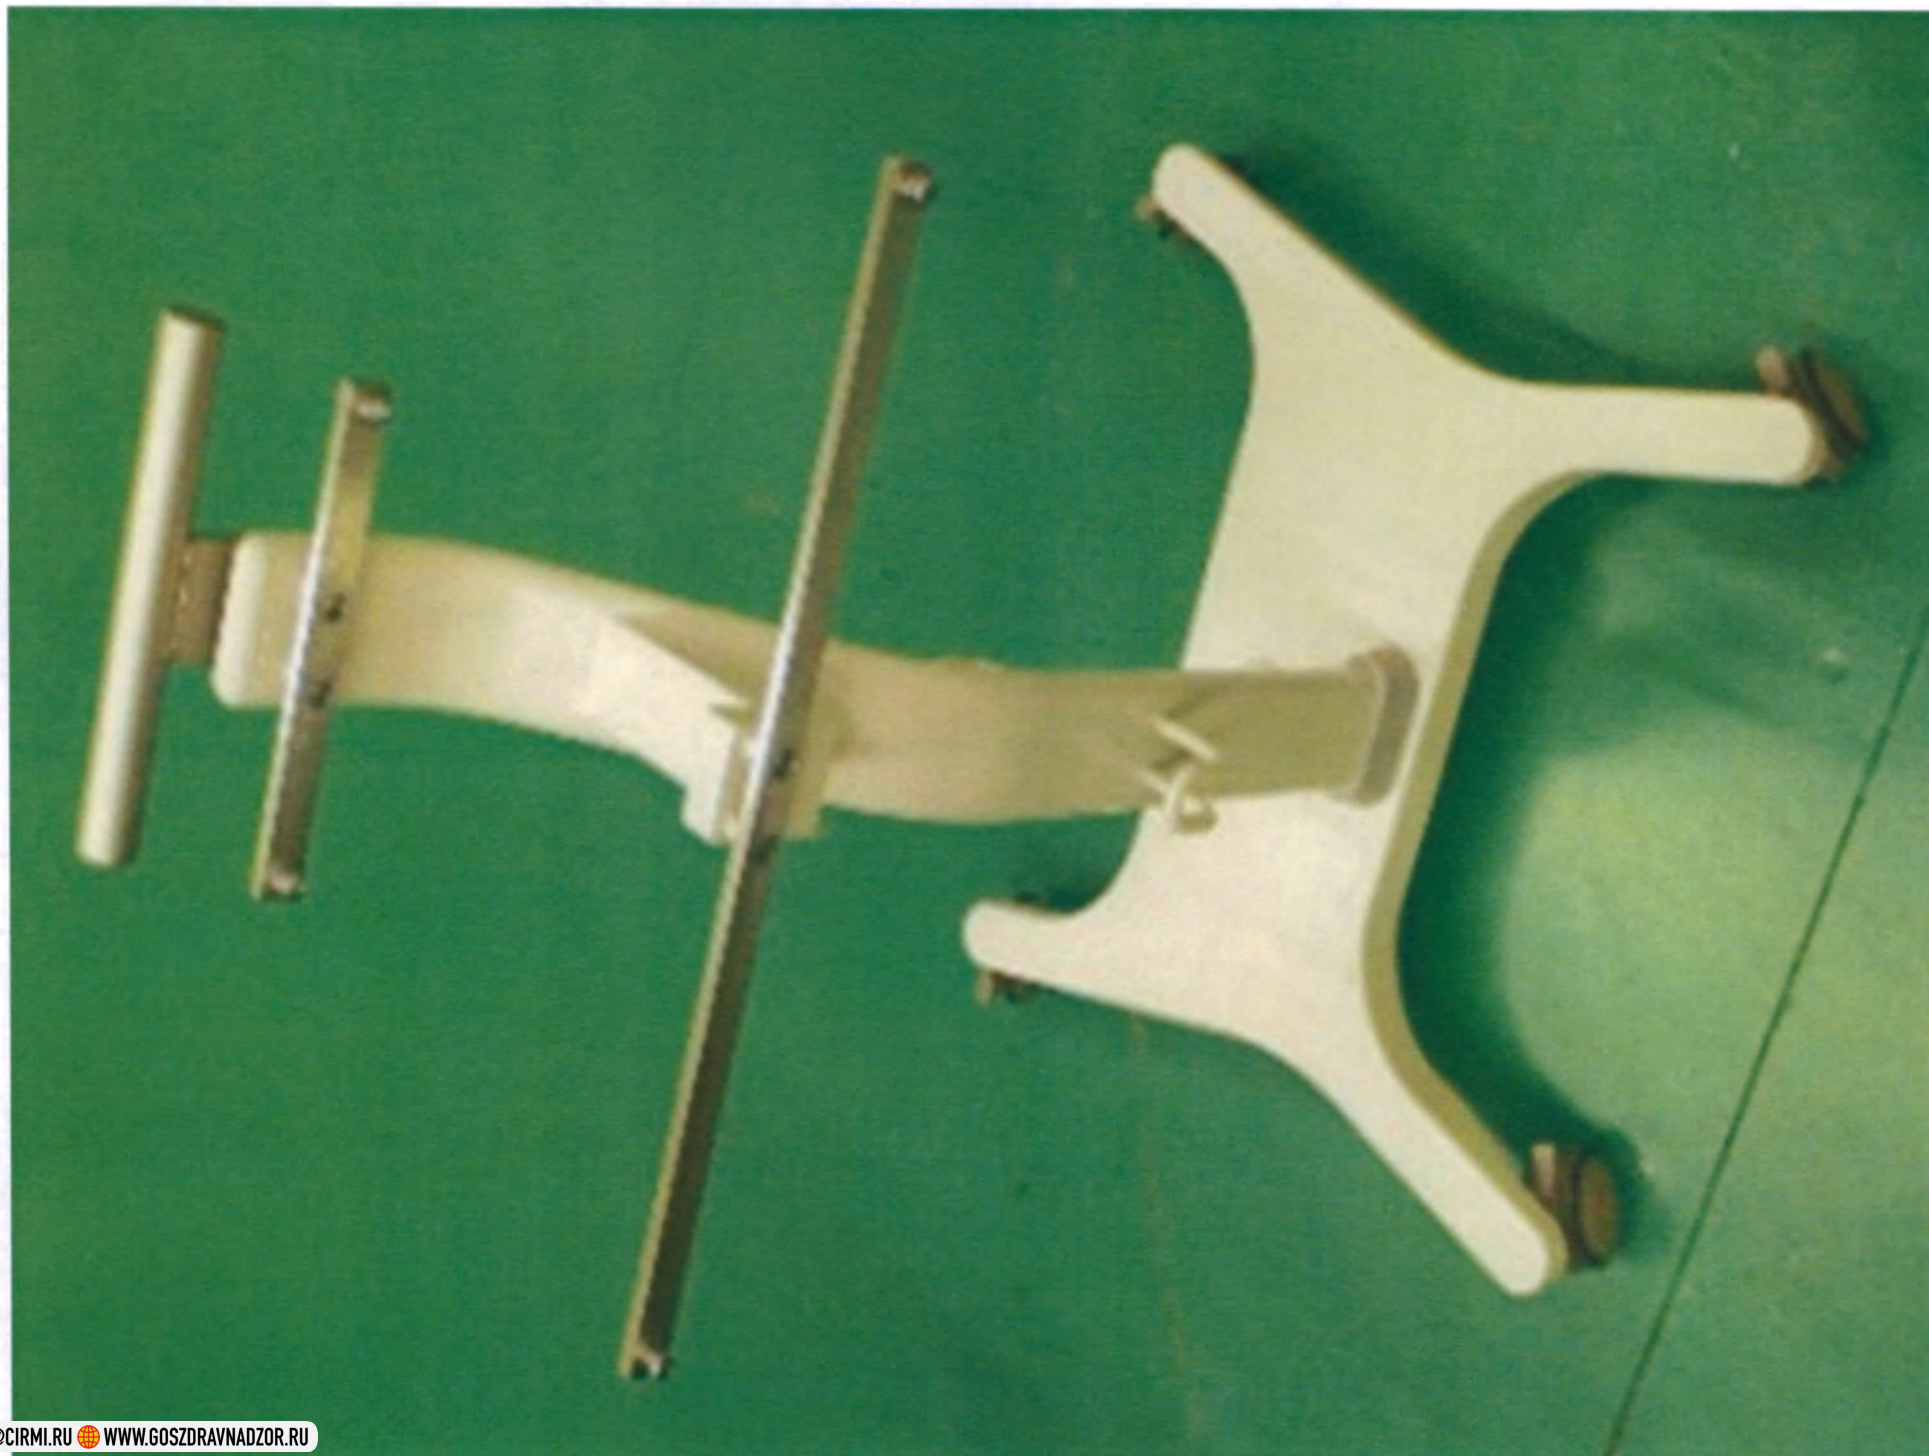



26. Боковая планшетная консоль стола с блоком переключателей.

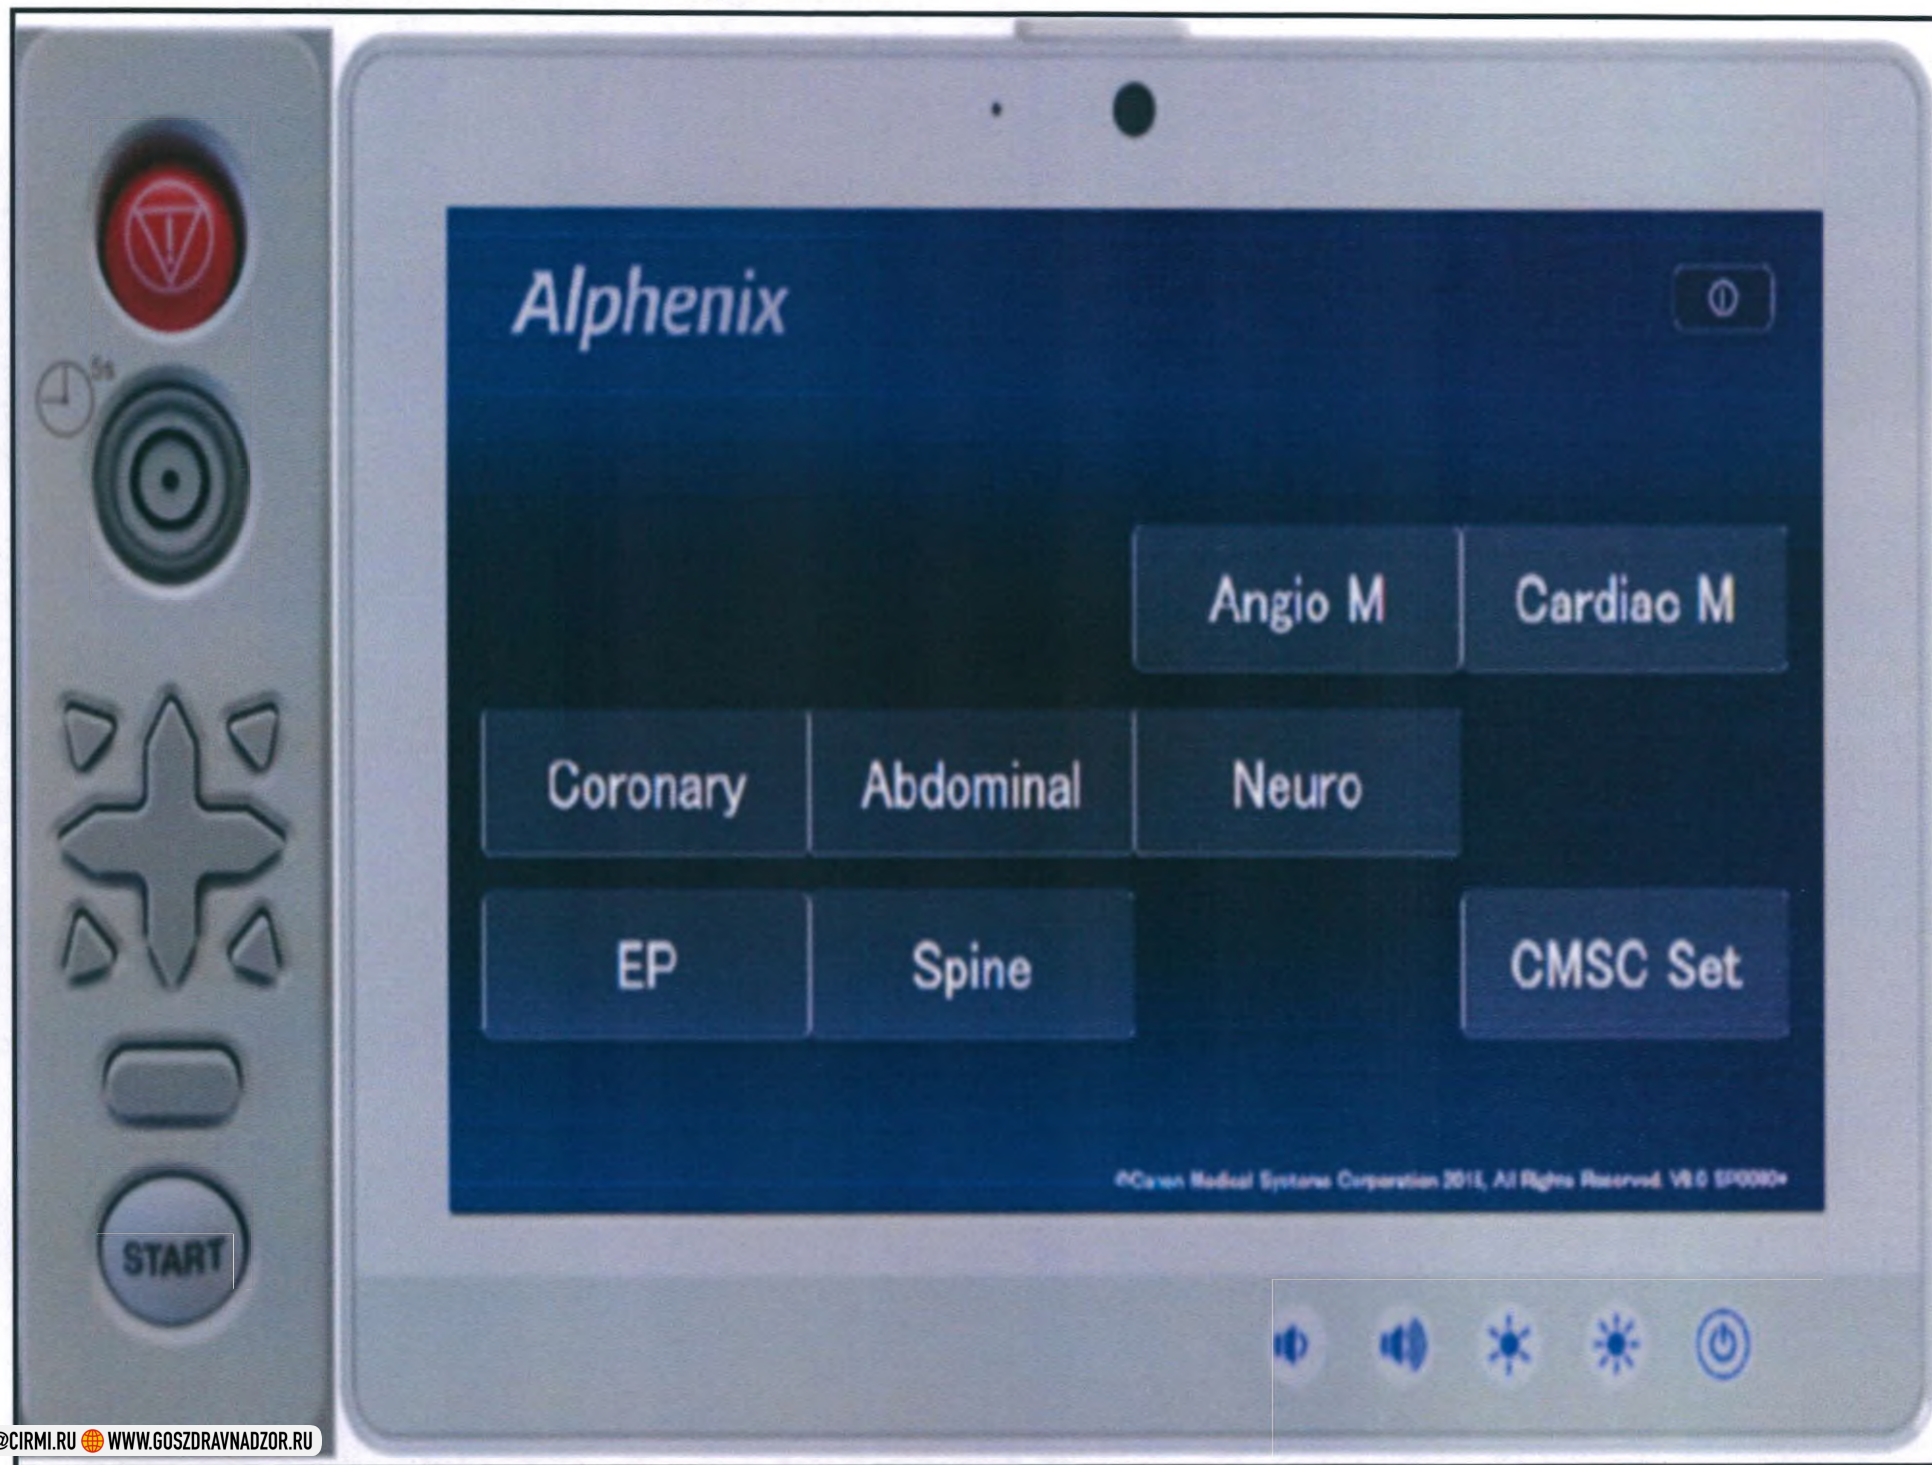

27. Вспомогательная планшетная консоль с блоком переключателей.

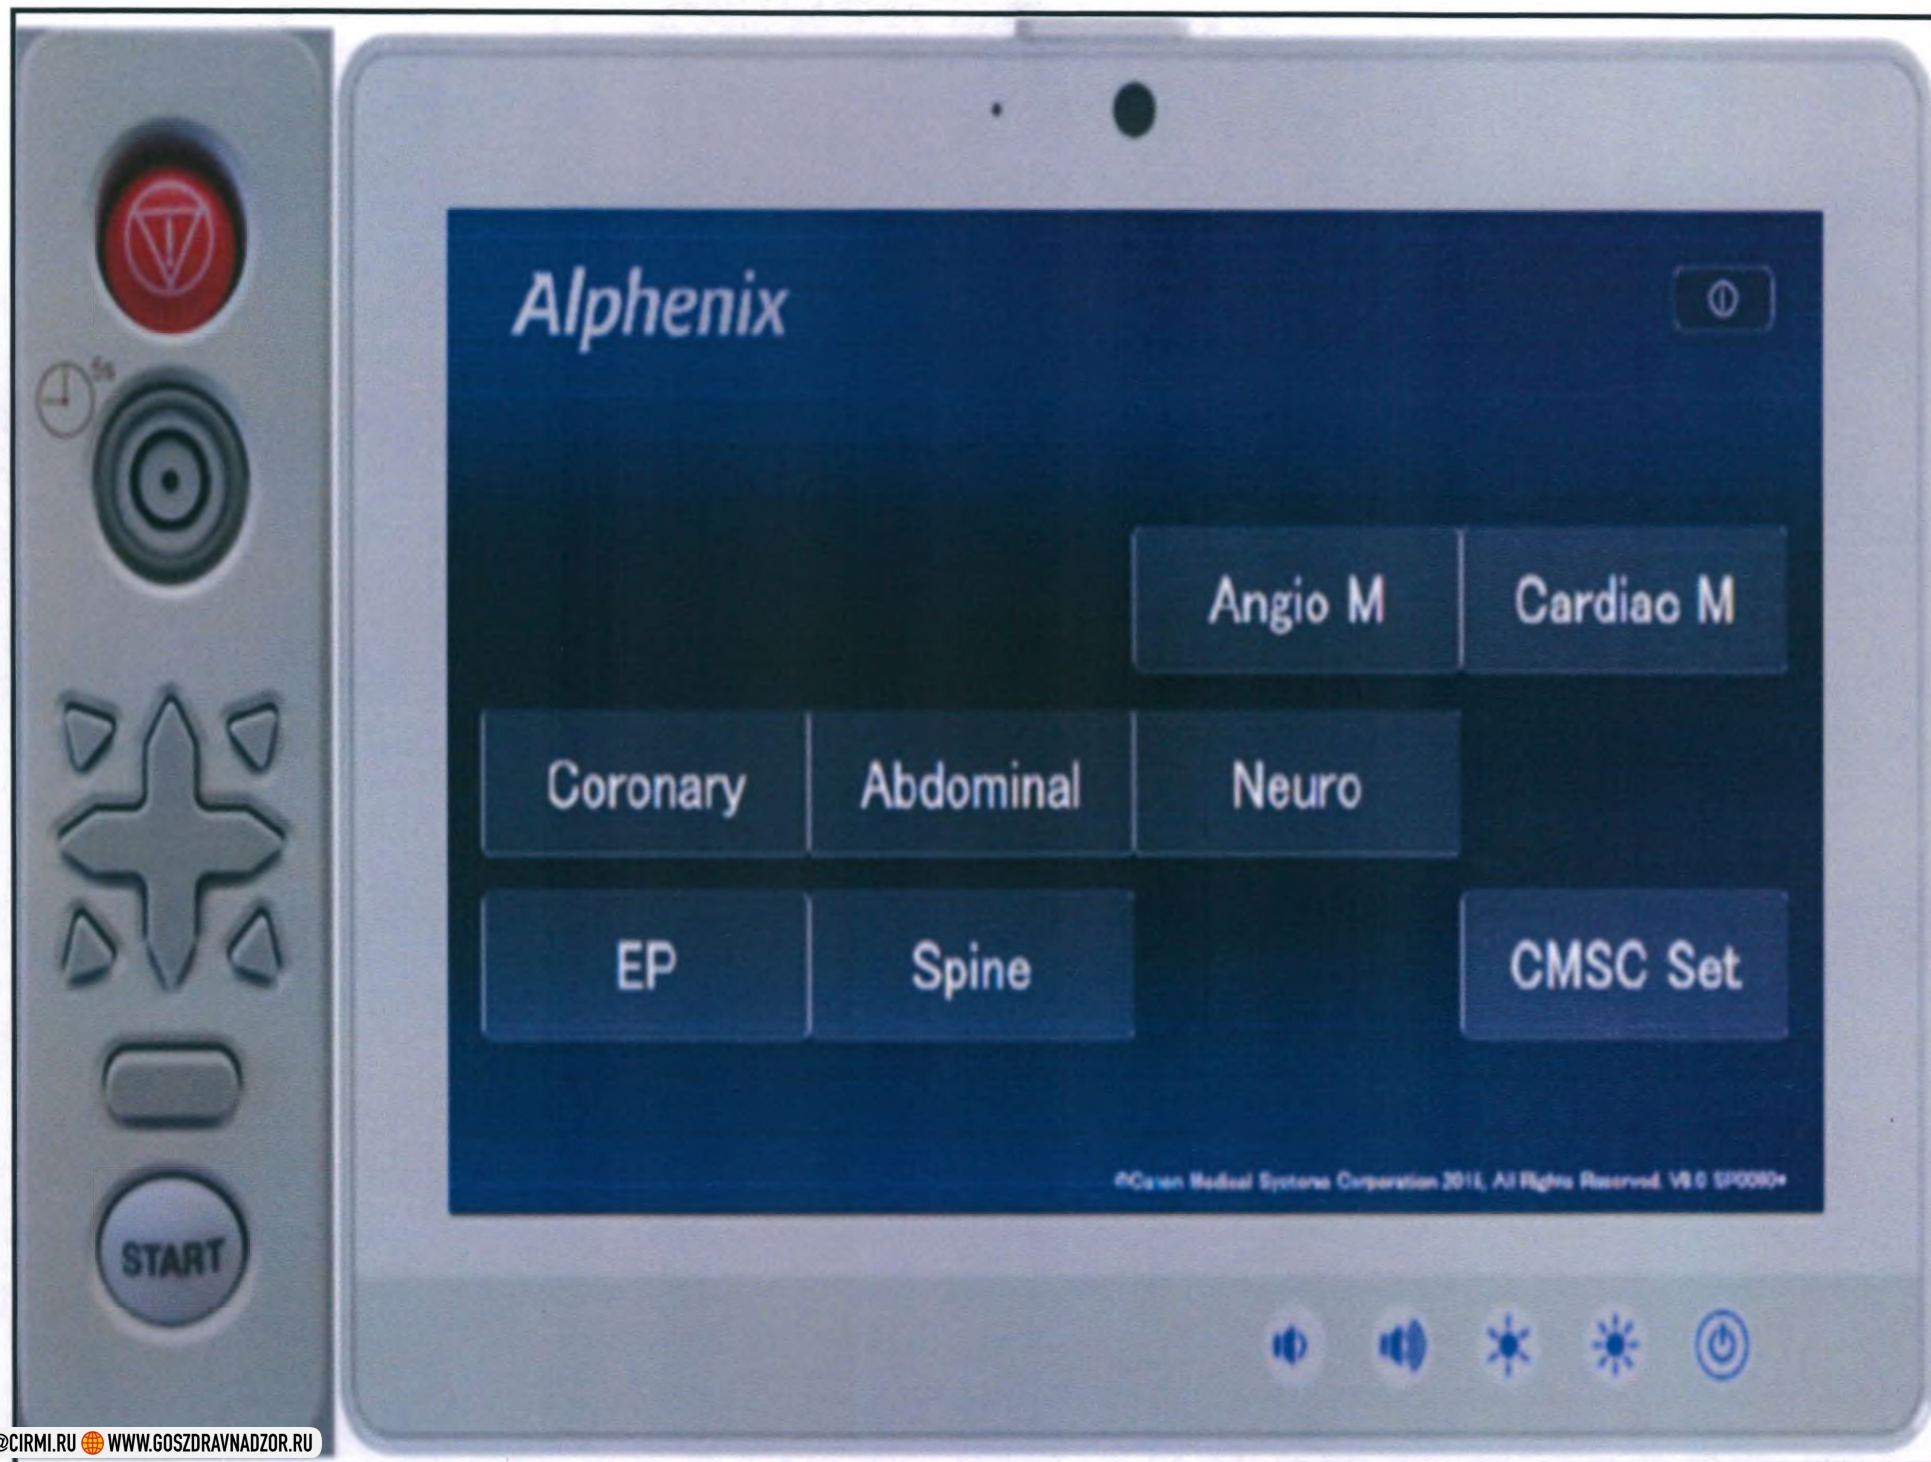

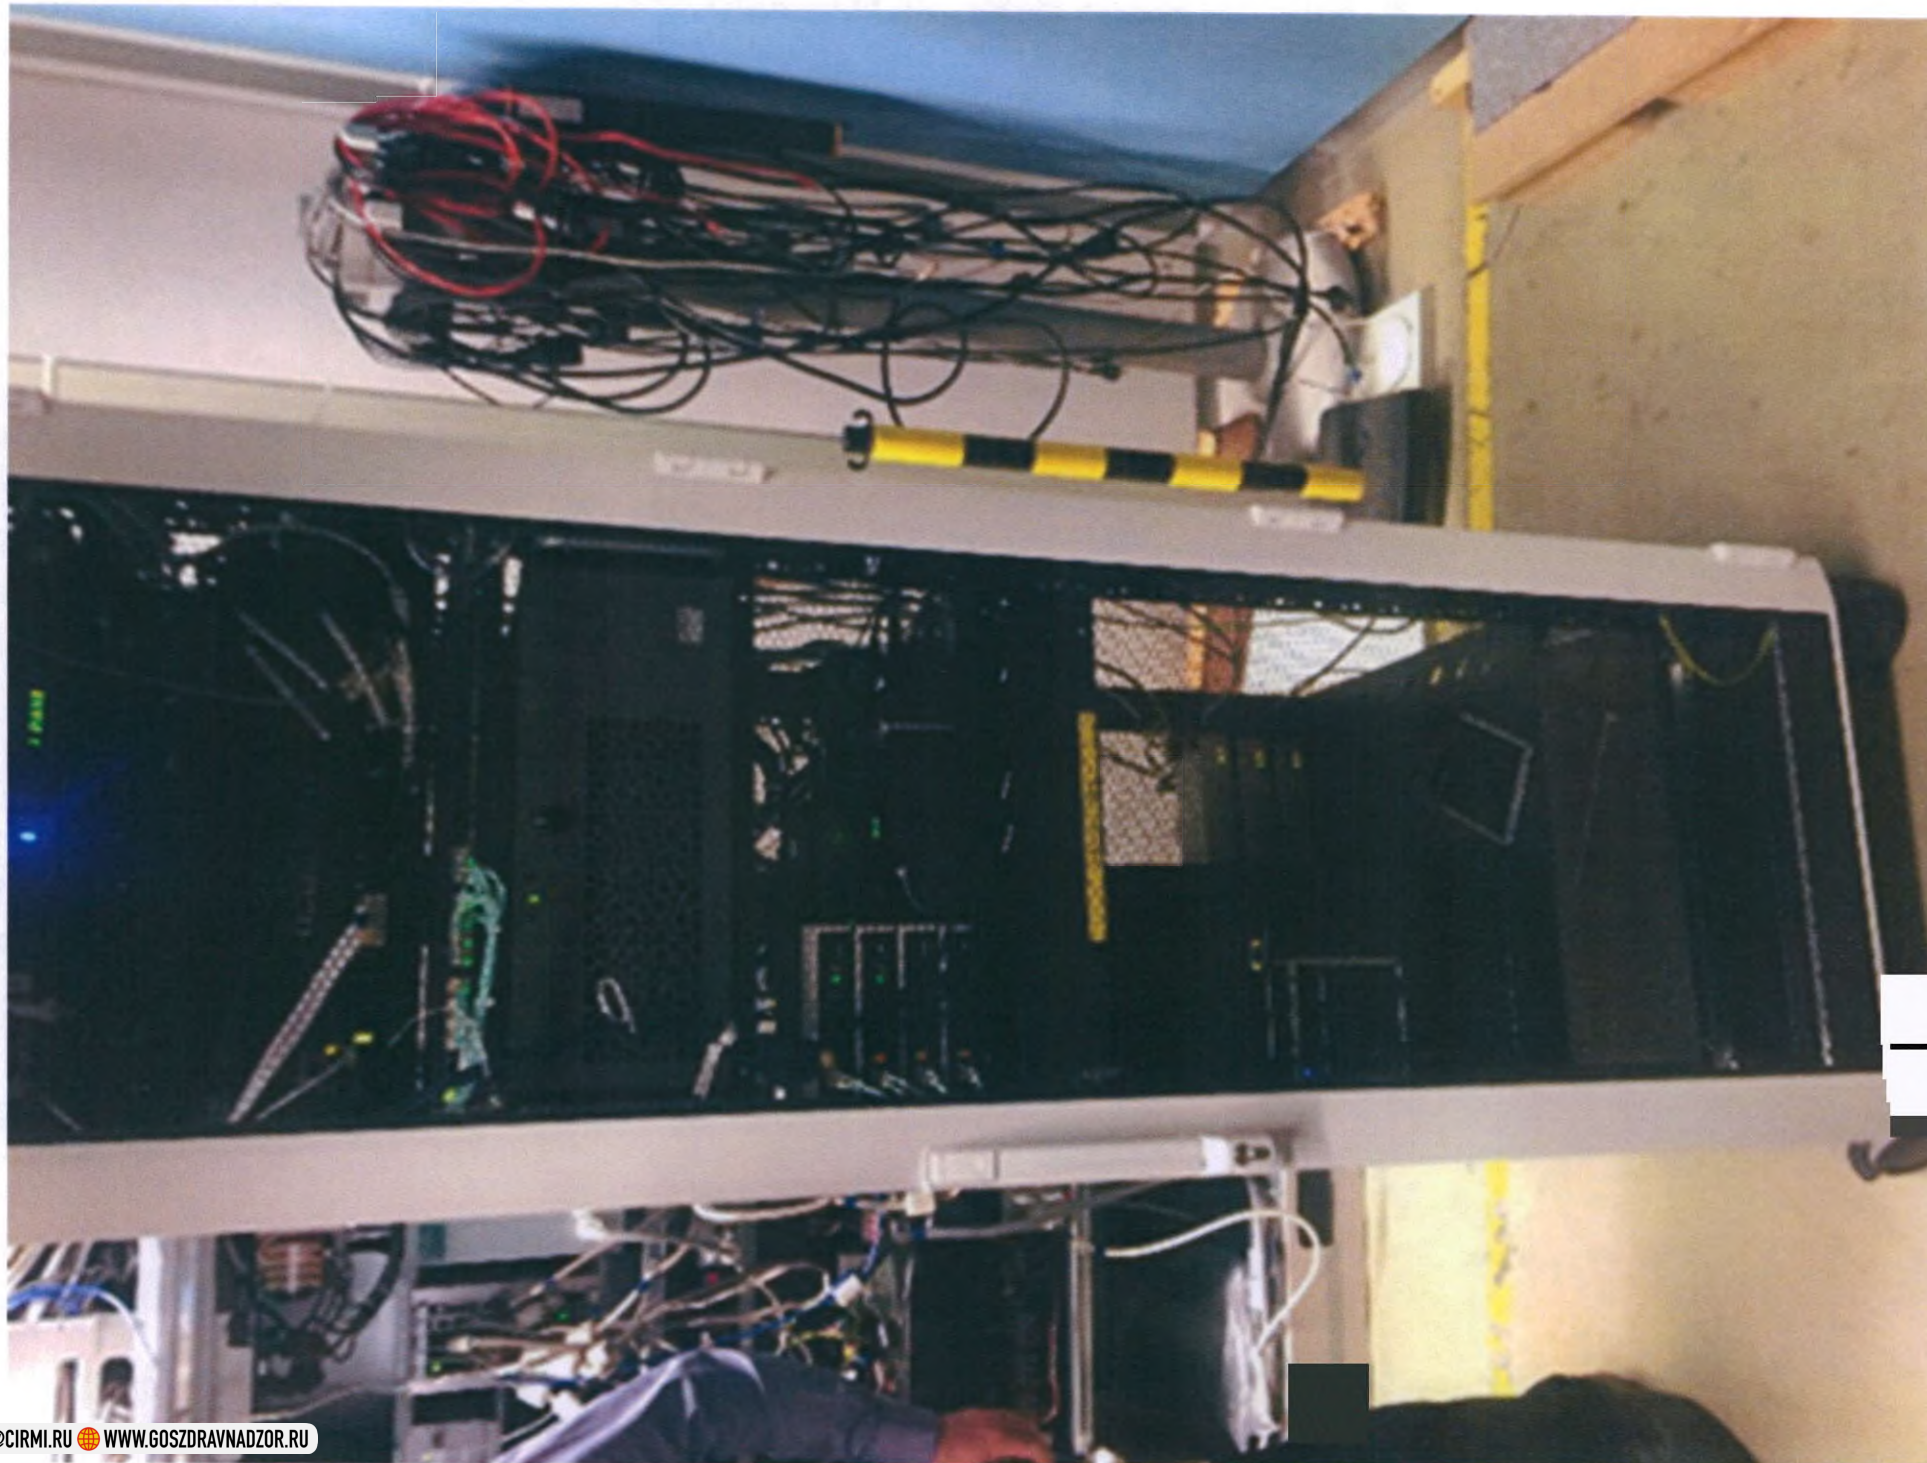

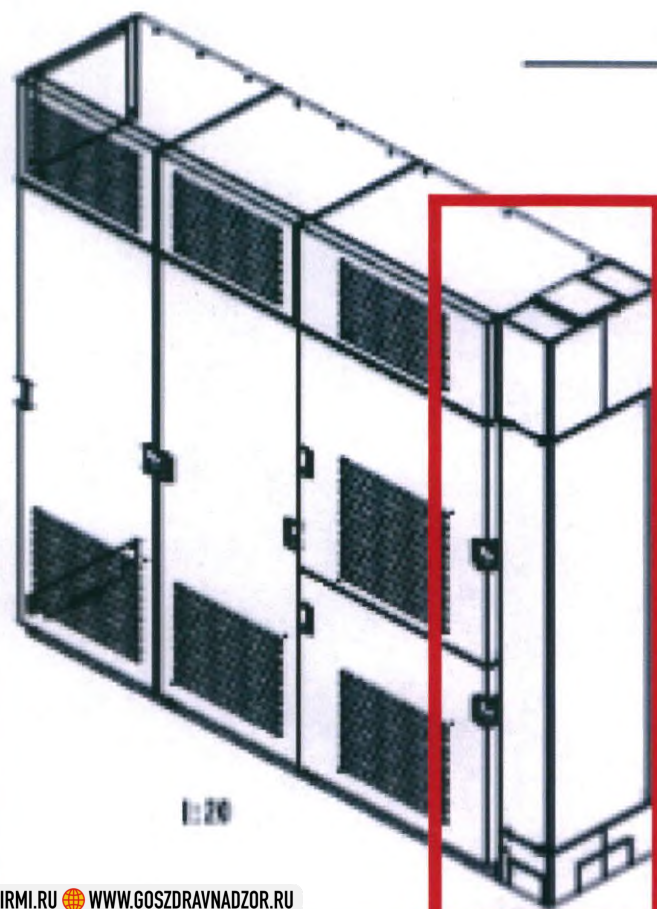




31. Комплект для добавления контрольного монитора.



32. Комплект принадлежностей для ступенчатой ЦСА.




Шаговое устройство
встроено внутрь
CAT-850B/B1

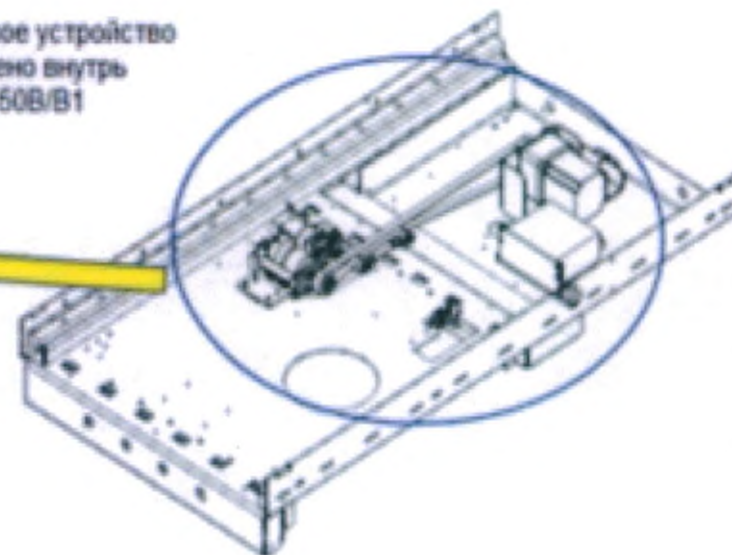





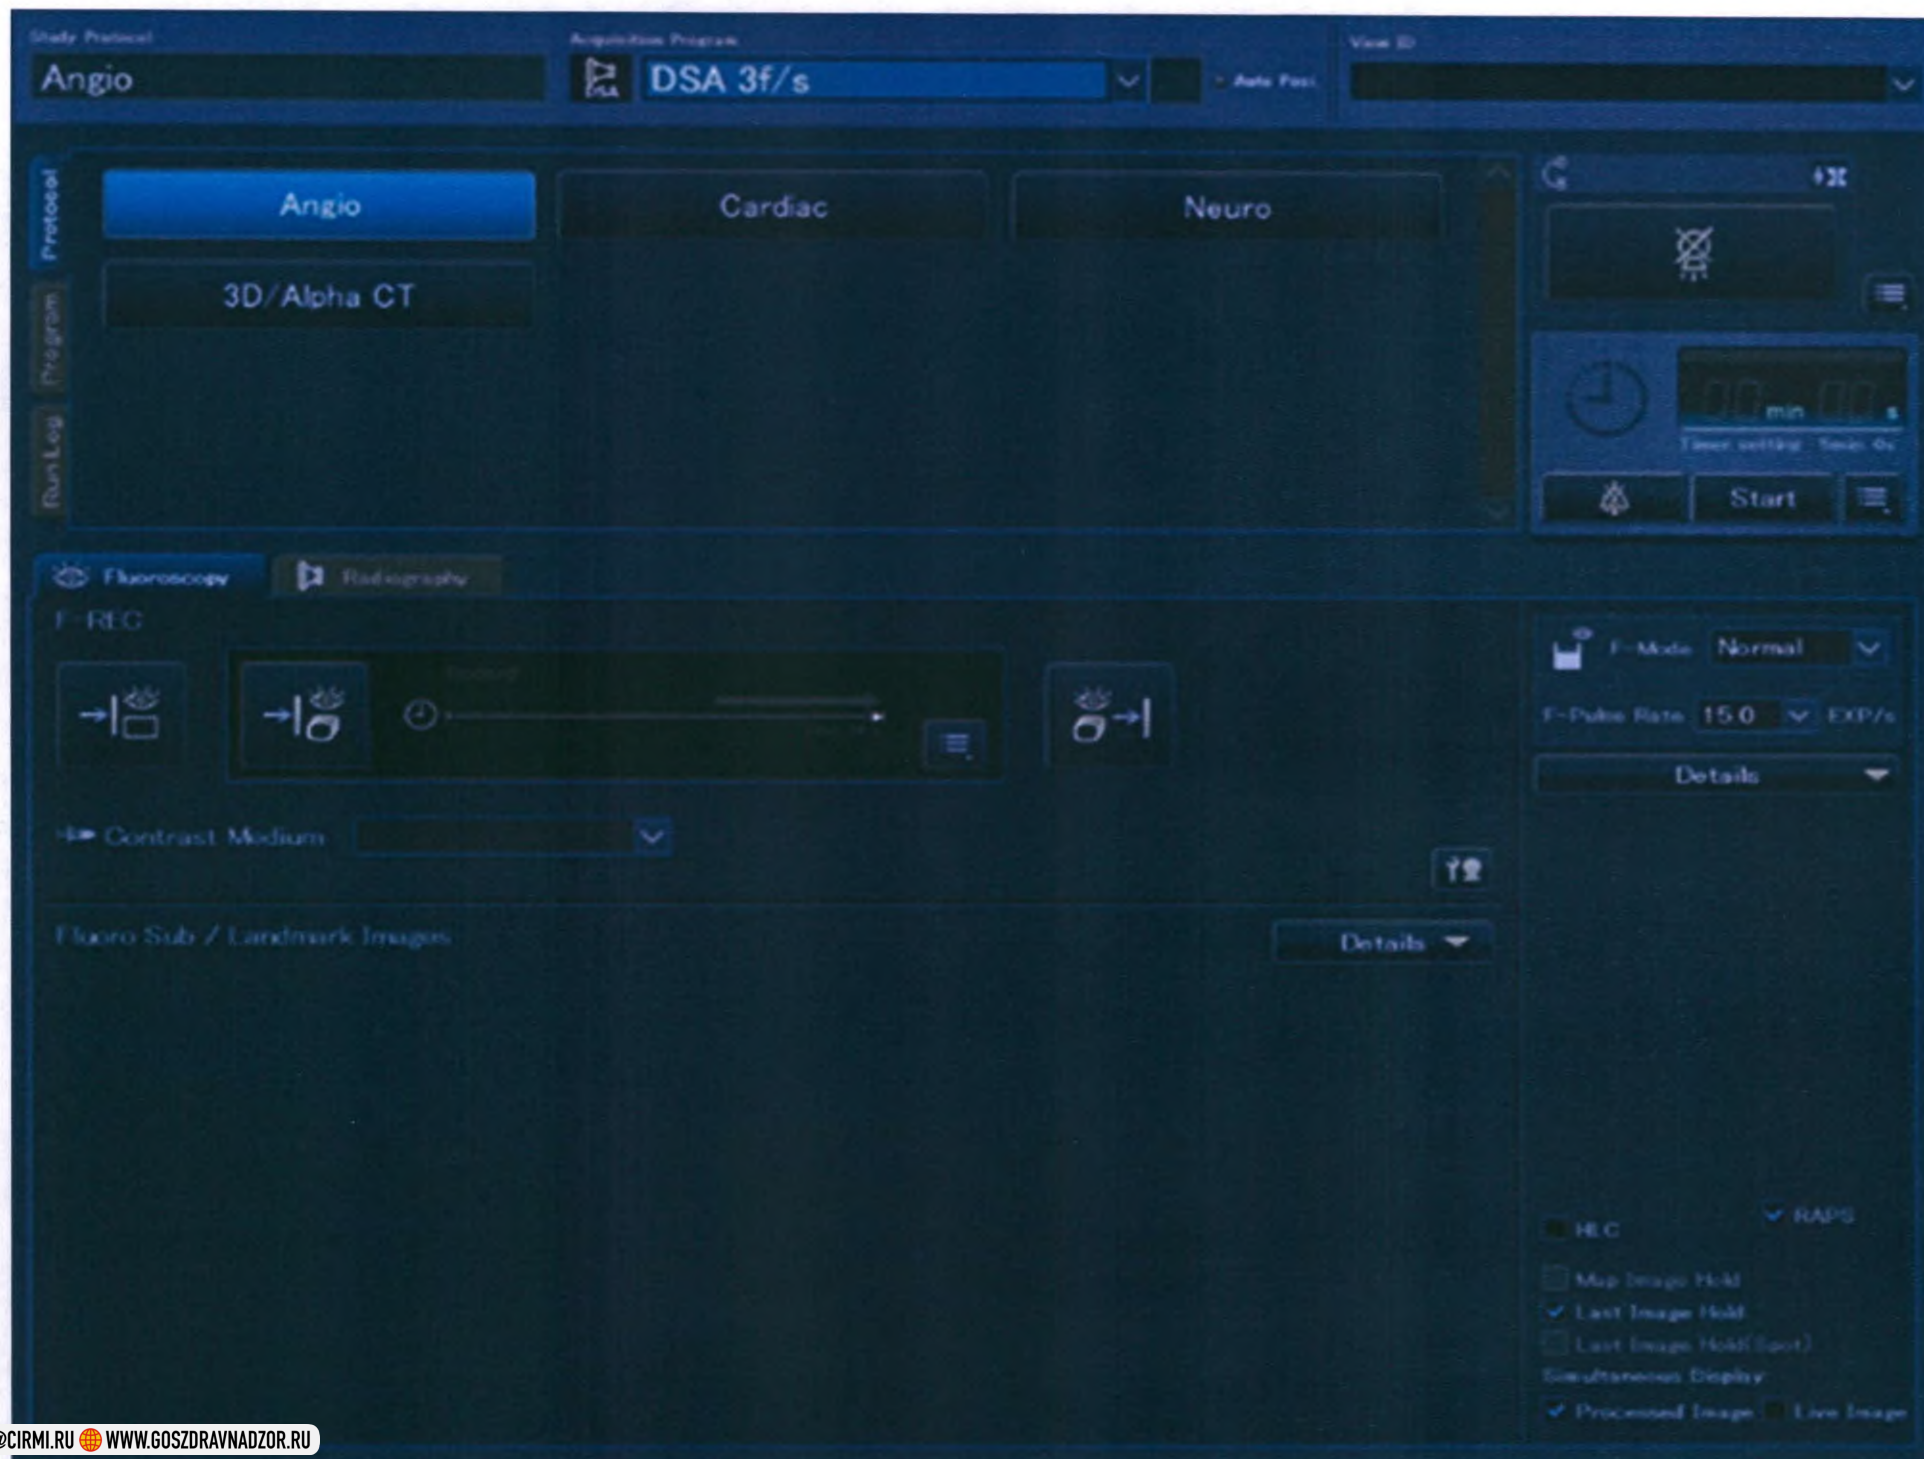

36. Модуль для низкоконтрастной визуализации (Alpha CT).

Study Protocol: 3D/Alpha CT Acquisition Program: CT Multi 5s 12" View ID: []

Protocol Parameters

System Mode
☐ Cardiac ☒ Angio 1
☐ Sequential Navi

Transfer Favorite
 System Param1
 System Param2

Fluoroscopy Radiography

Tube Voltage 75 kV Focus
 Tube Current 320 mA Gain 100
 Pulse Width 40.0 ms

Target Dose 0.88 μGy
 Details

Test Shot Advanced Presets AEC Param.

Contrast Medium Floor Rot (deg.) 0

Phase1 Phase2 Phase3

Exposure Time(s) 4.0 4.0 4.0
 Delay From Injection Start(s) 6.0 16.0 26.0
 Speed(deg./s) 50.0 Deg./Frames 1.0

Rate(f/s) 60.0 Frames 223 x 3

SID 120
 FOV 12.0
☒ FOV Linkage


Radiographic Range
 RAO 120 LAO 120
 CRA 0 CRA 0

Function *Quality
 Mode Voxel Size
 1 Bone&Vessel 512
 2 No Select 512

OK Cancel

Total Time(s) 30.0 No. of frames 669 Total Deg 720



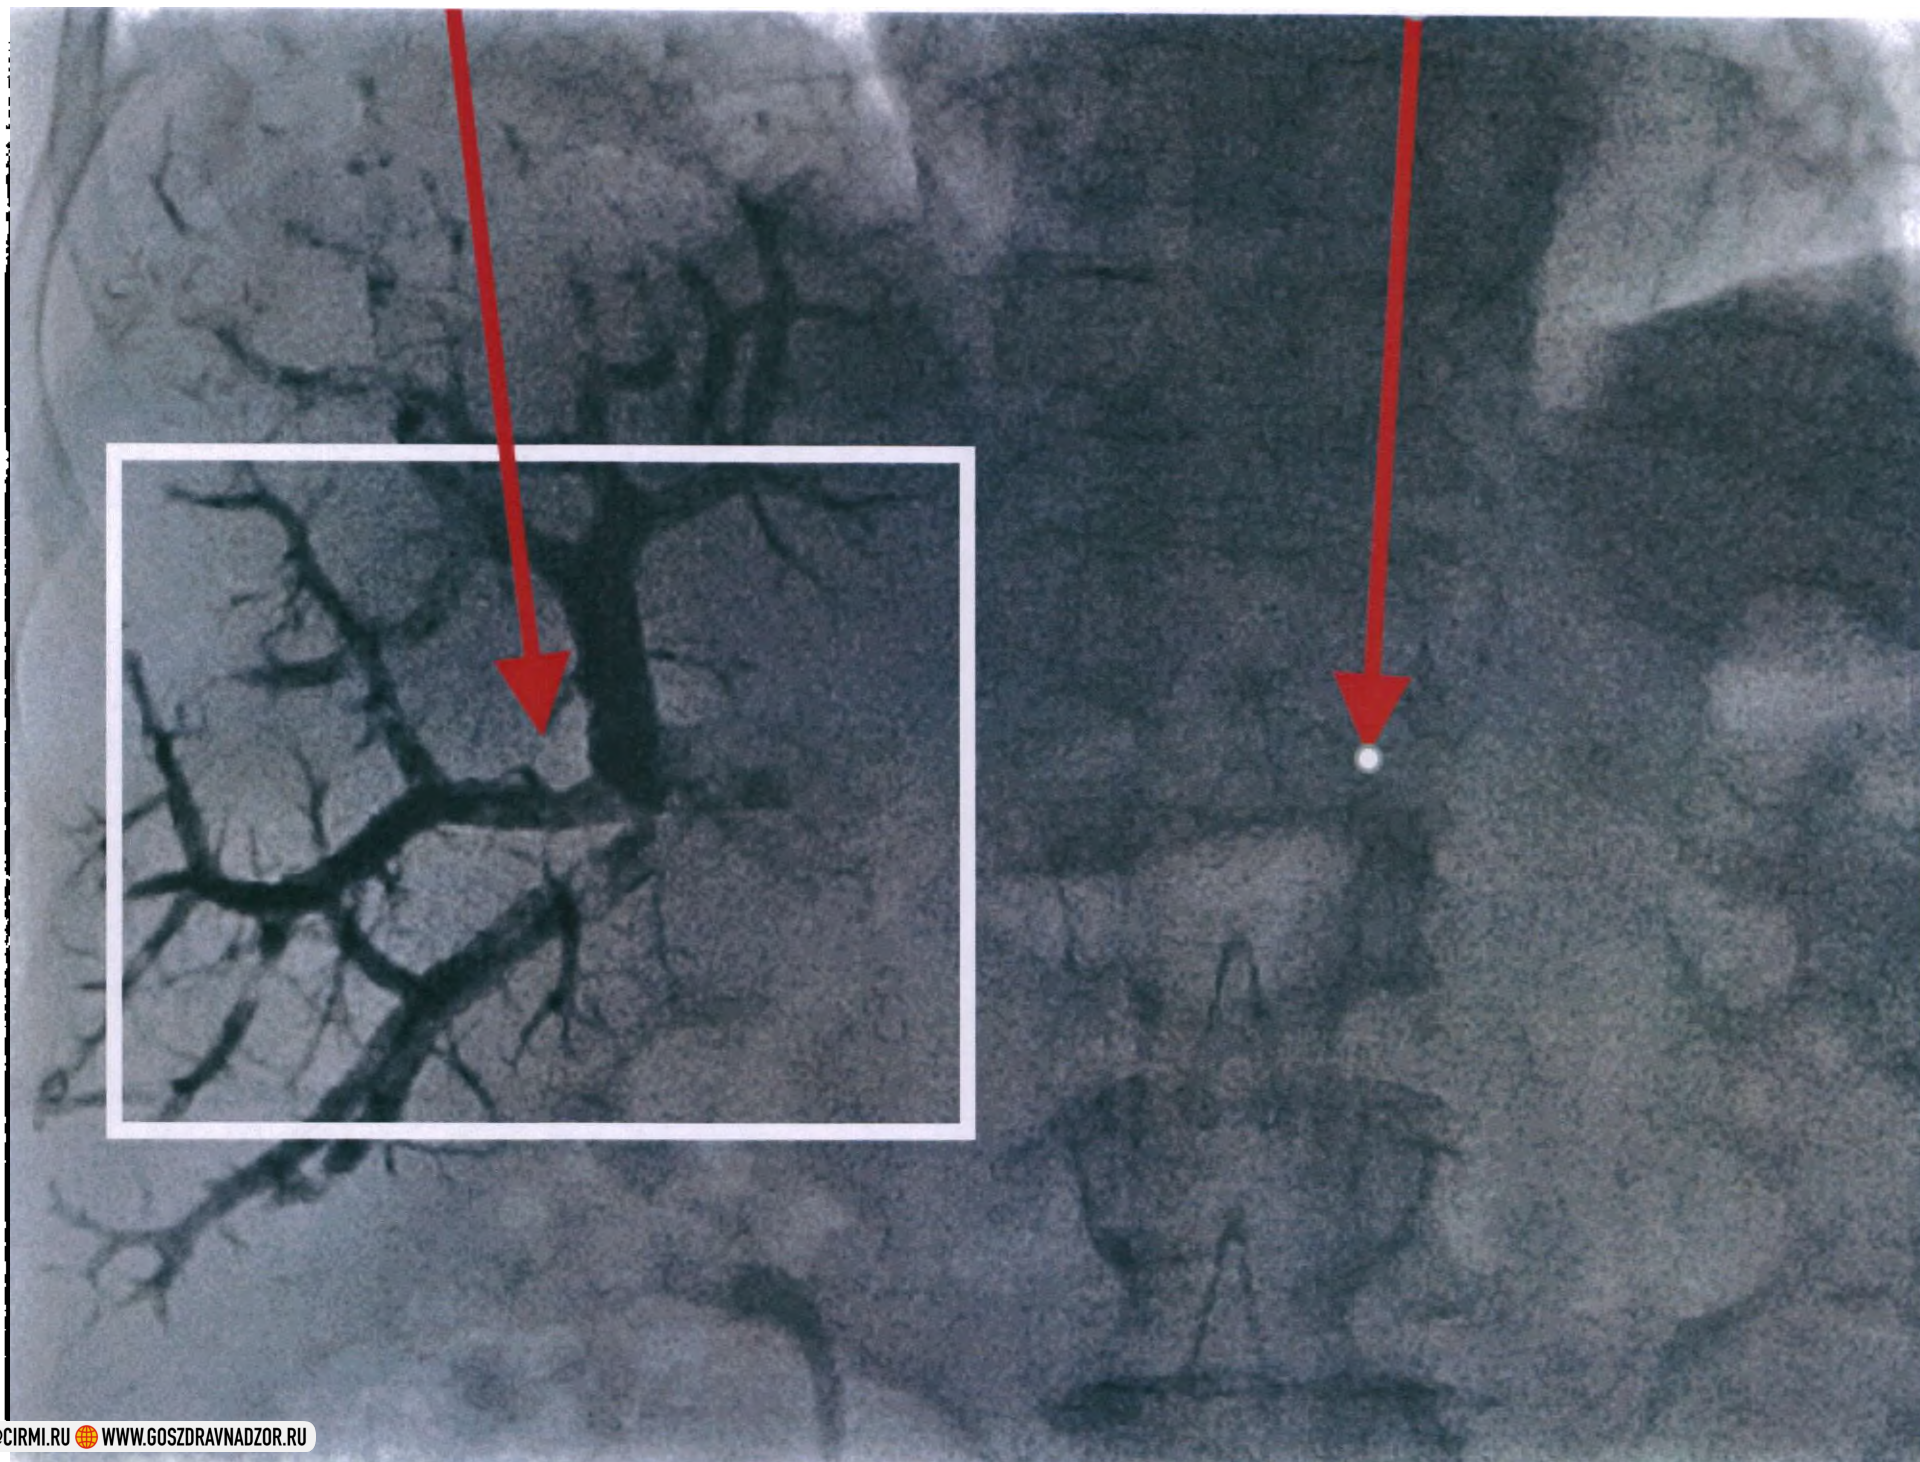

CAAS SETTINGS

CAL | LVA | RVA | QCA | QVA | About

Local Reference Method

☒ Mean local 1
 ☐ Mean local 2
 ☐ Interpolated

Default Analysis Method: Total Analyzed Segment

Local Diam Average Width: 3 mm

Local Flat Average Width: 3 mm

Maximum Diameter: 50


☒ Snap Lesion At Local Minimum

Default


OK Cancel






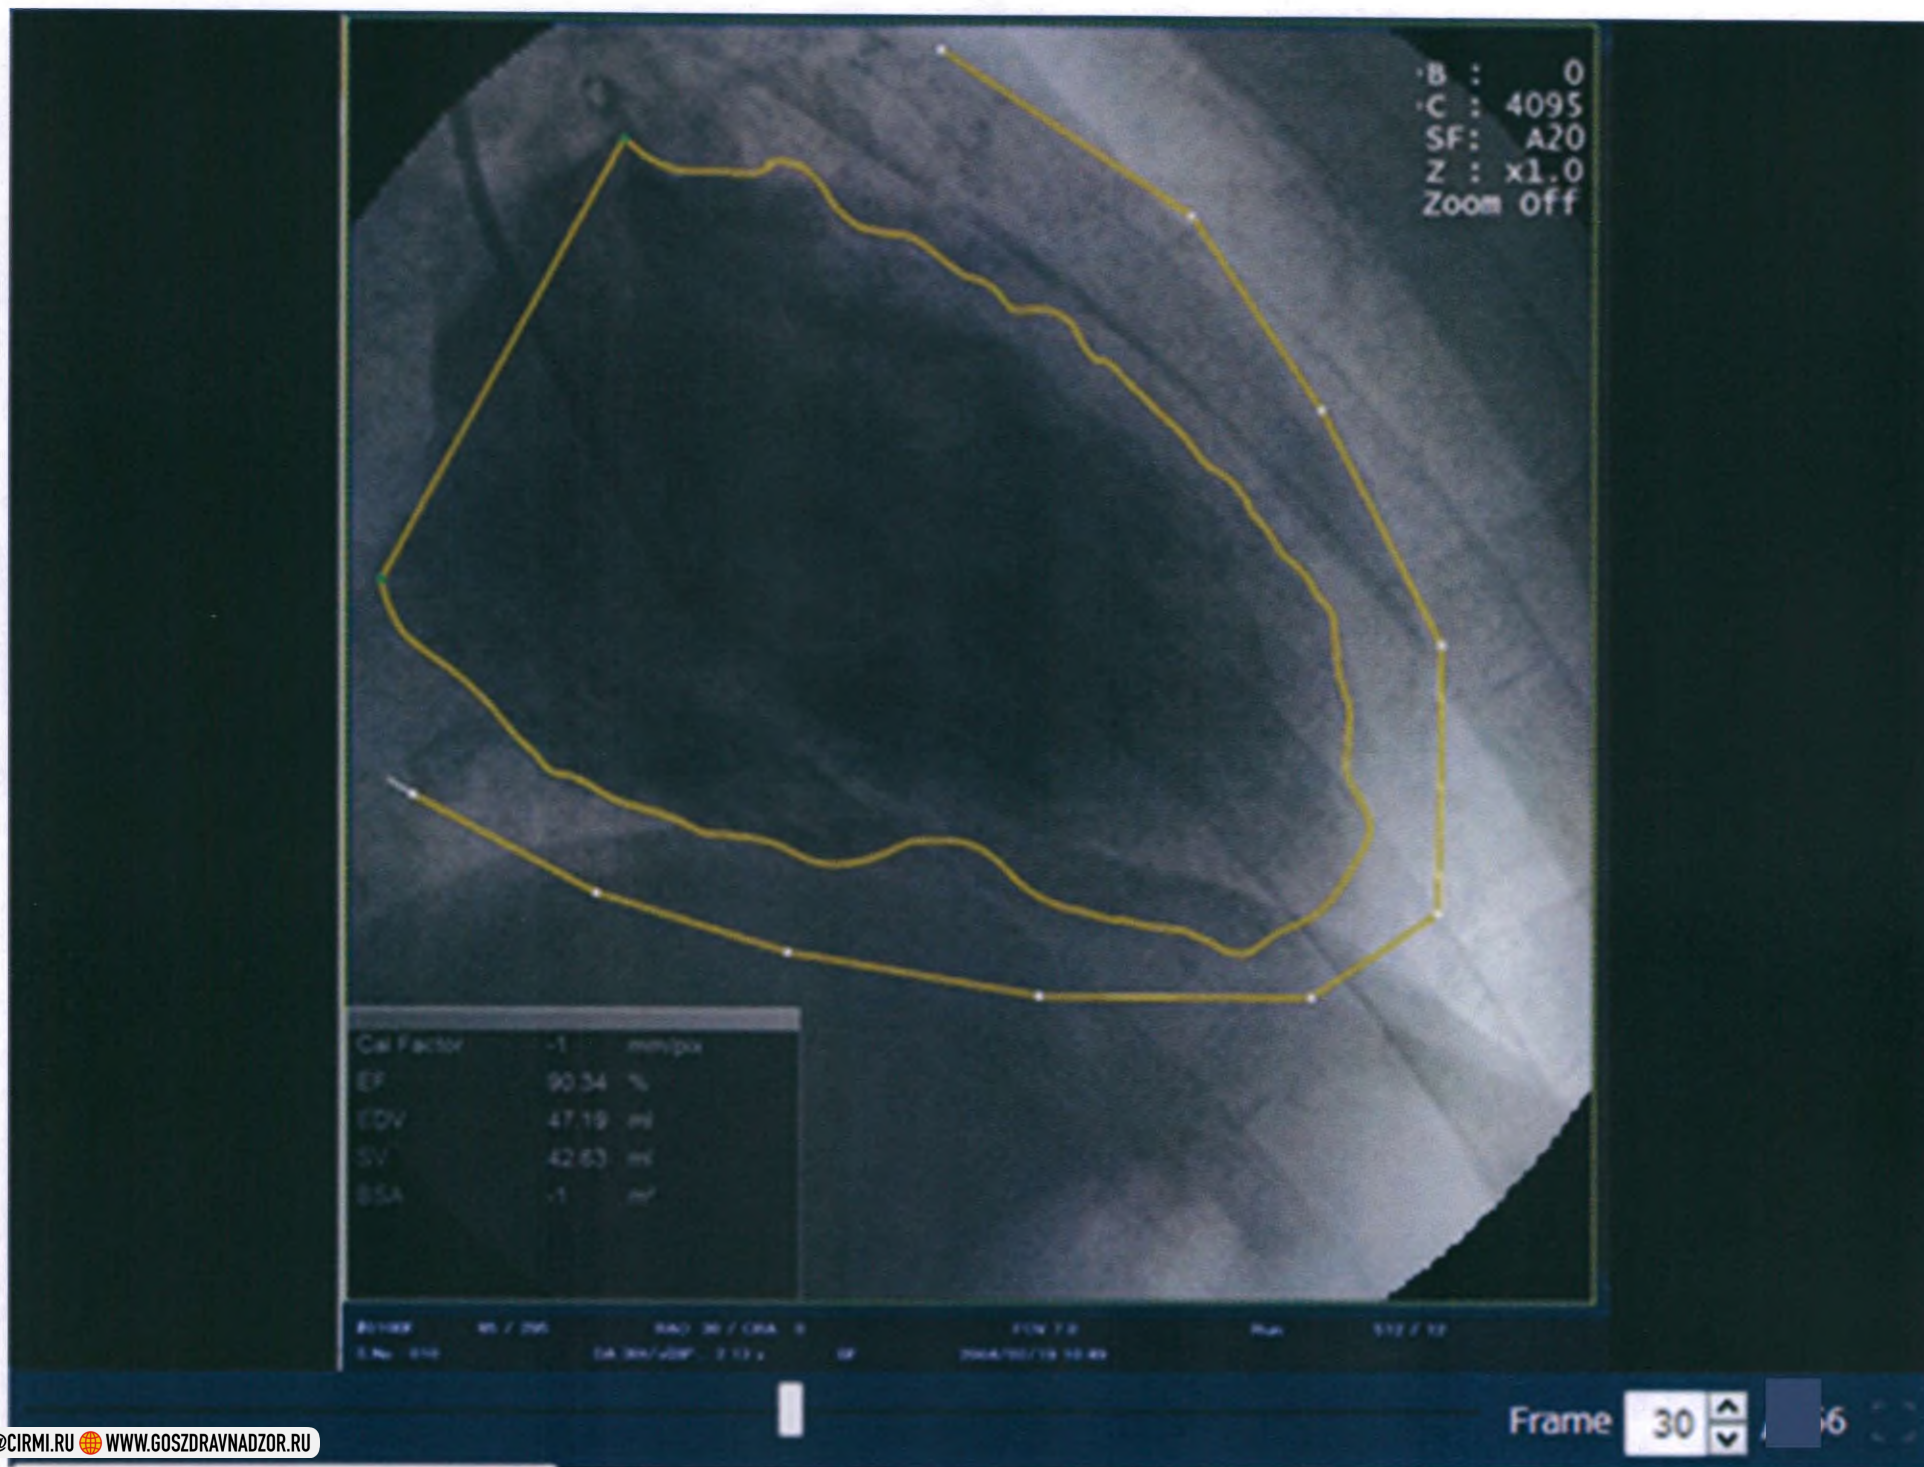




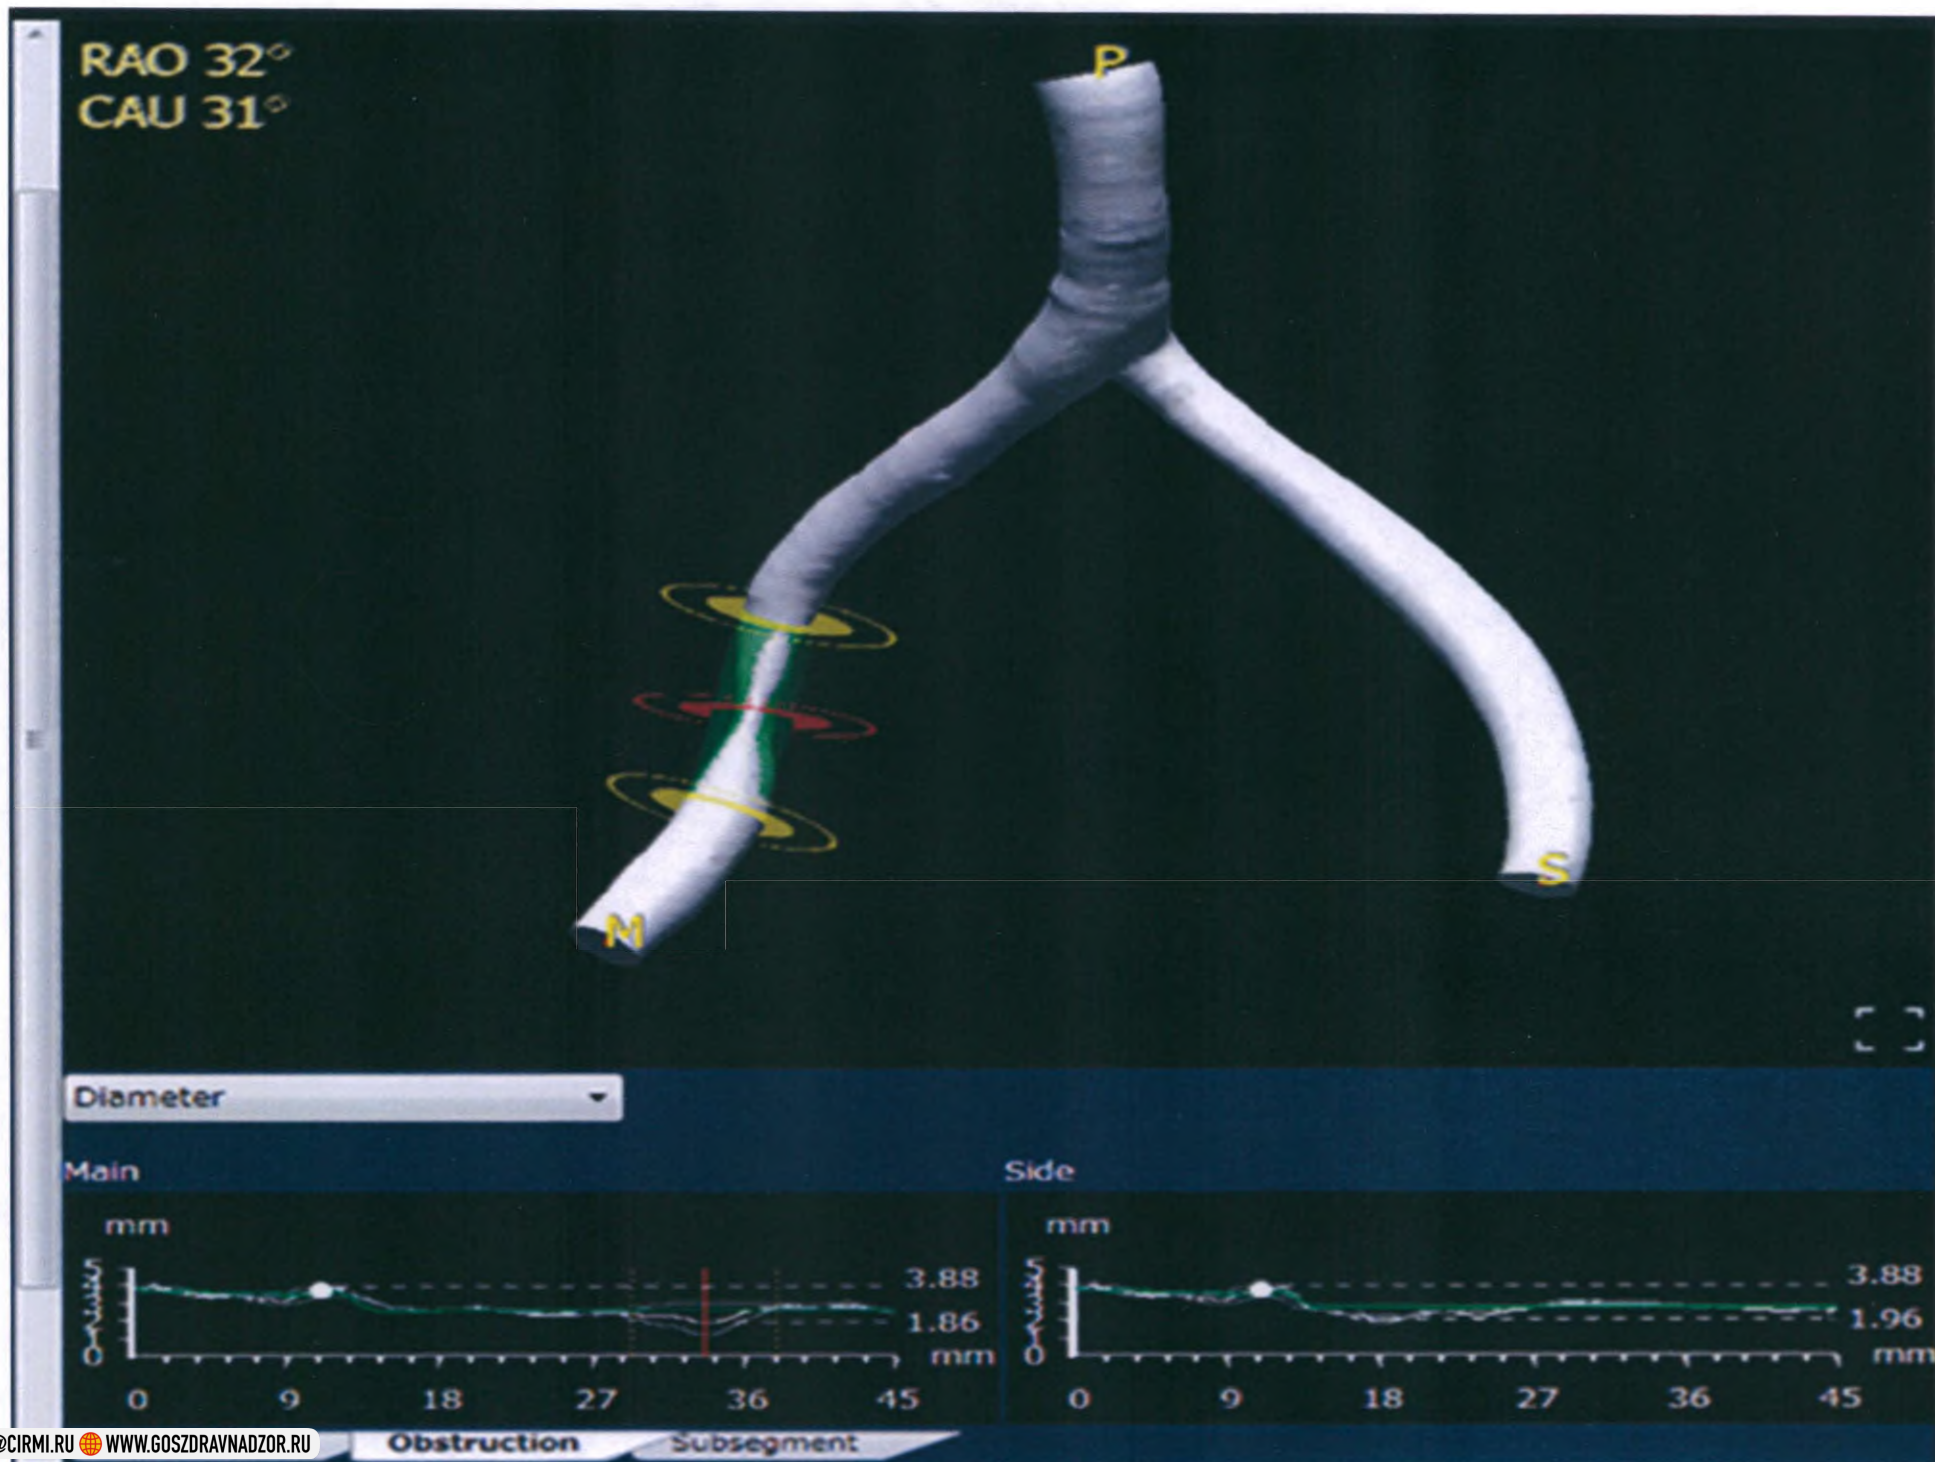


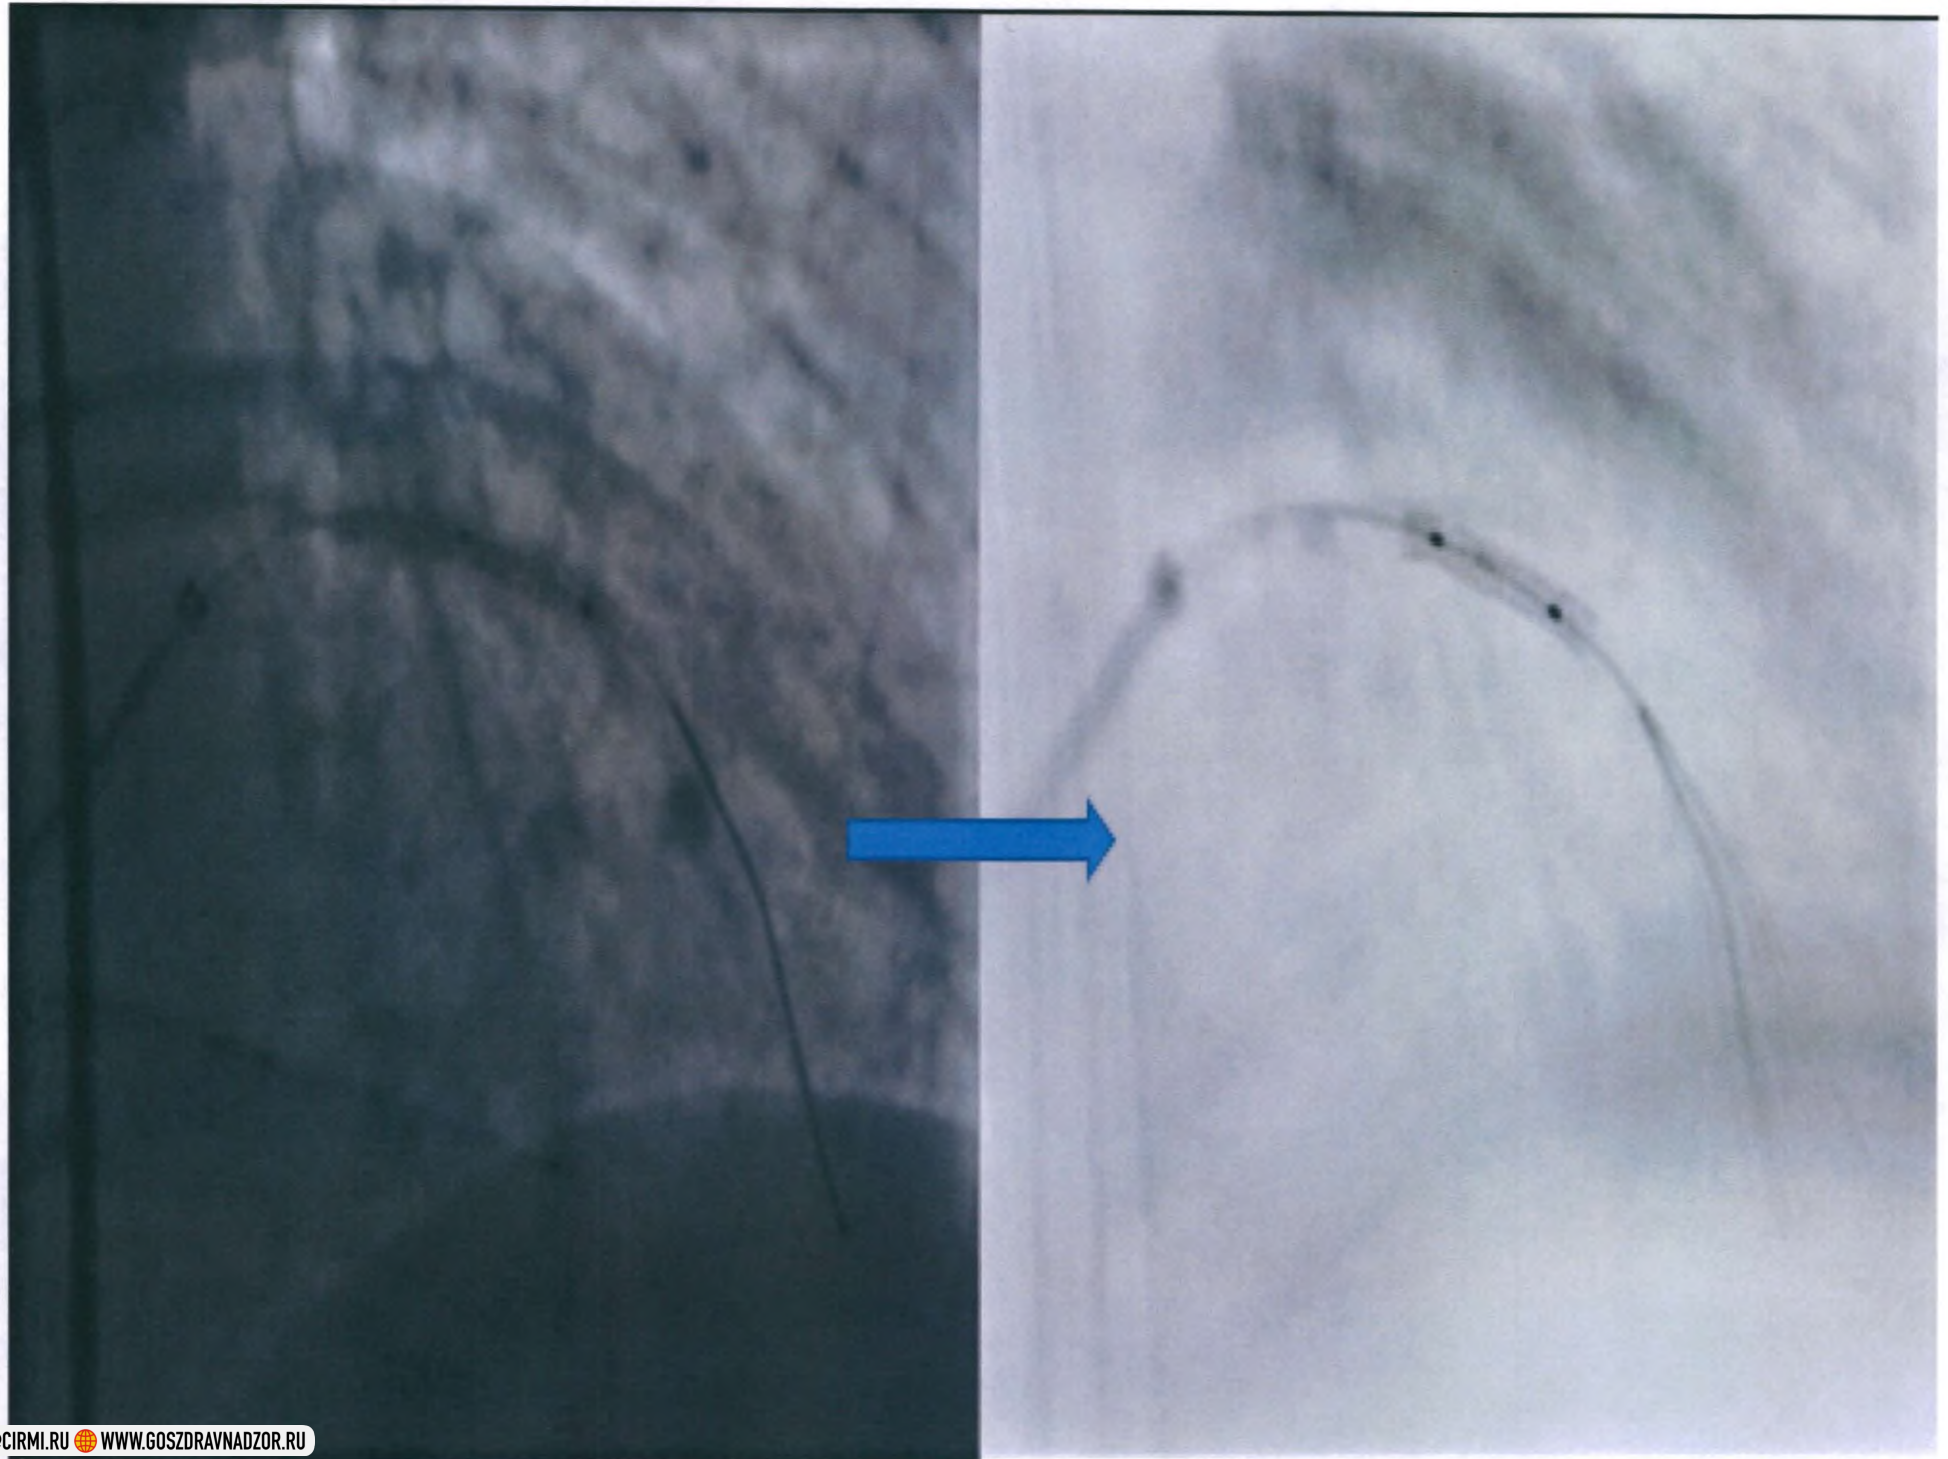


46. Монитор 19-дюймовый или монитор 34-дюймовый, не более 5 шт.

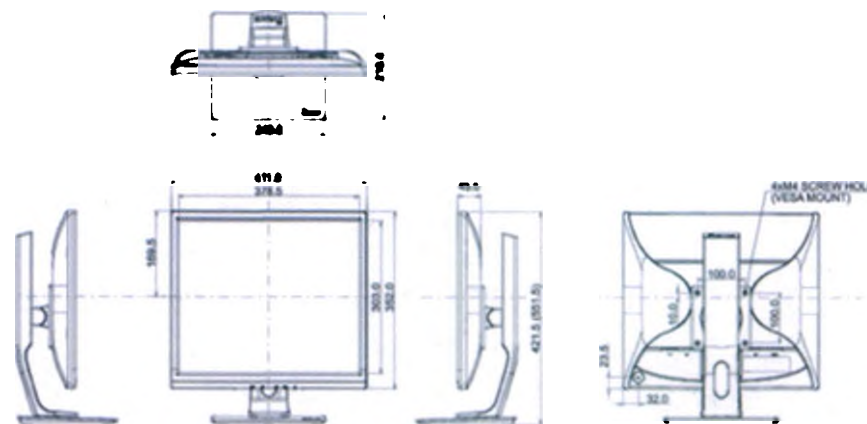


Модель монитора «IIYAMA Prolite», размер диагонали 19 дюймов

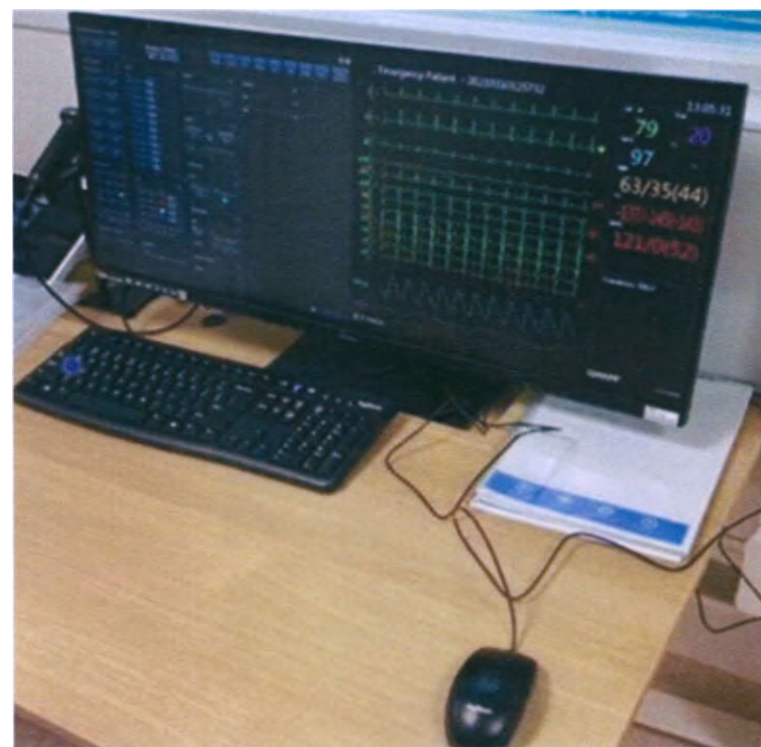



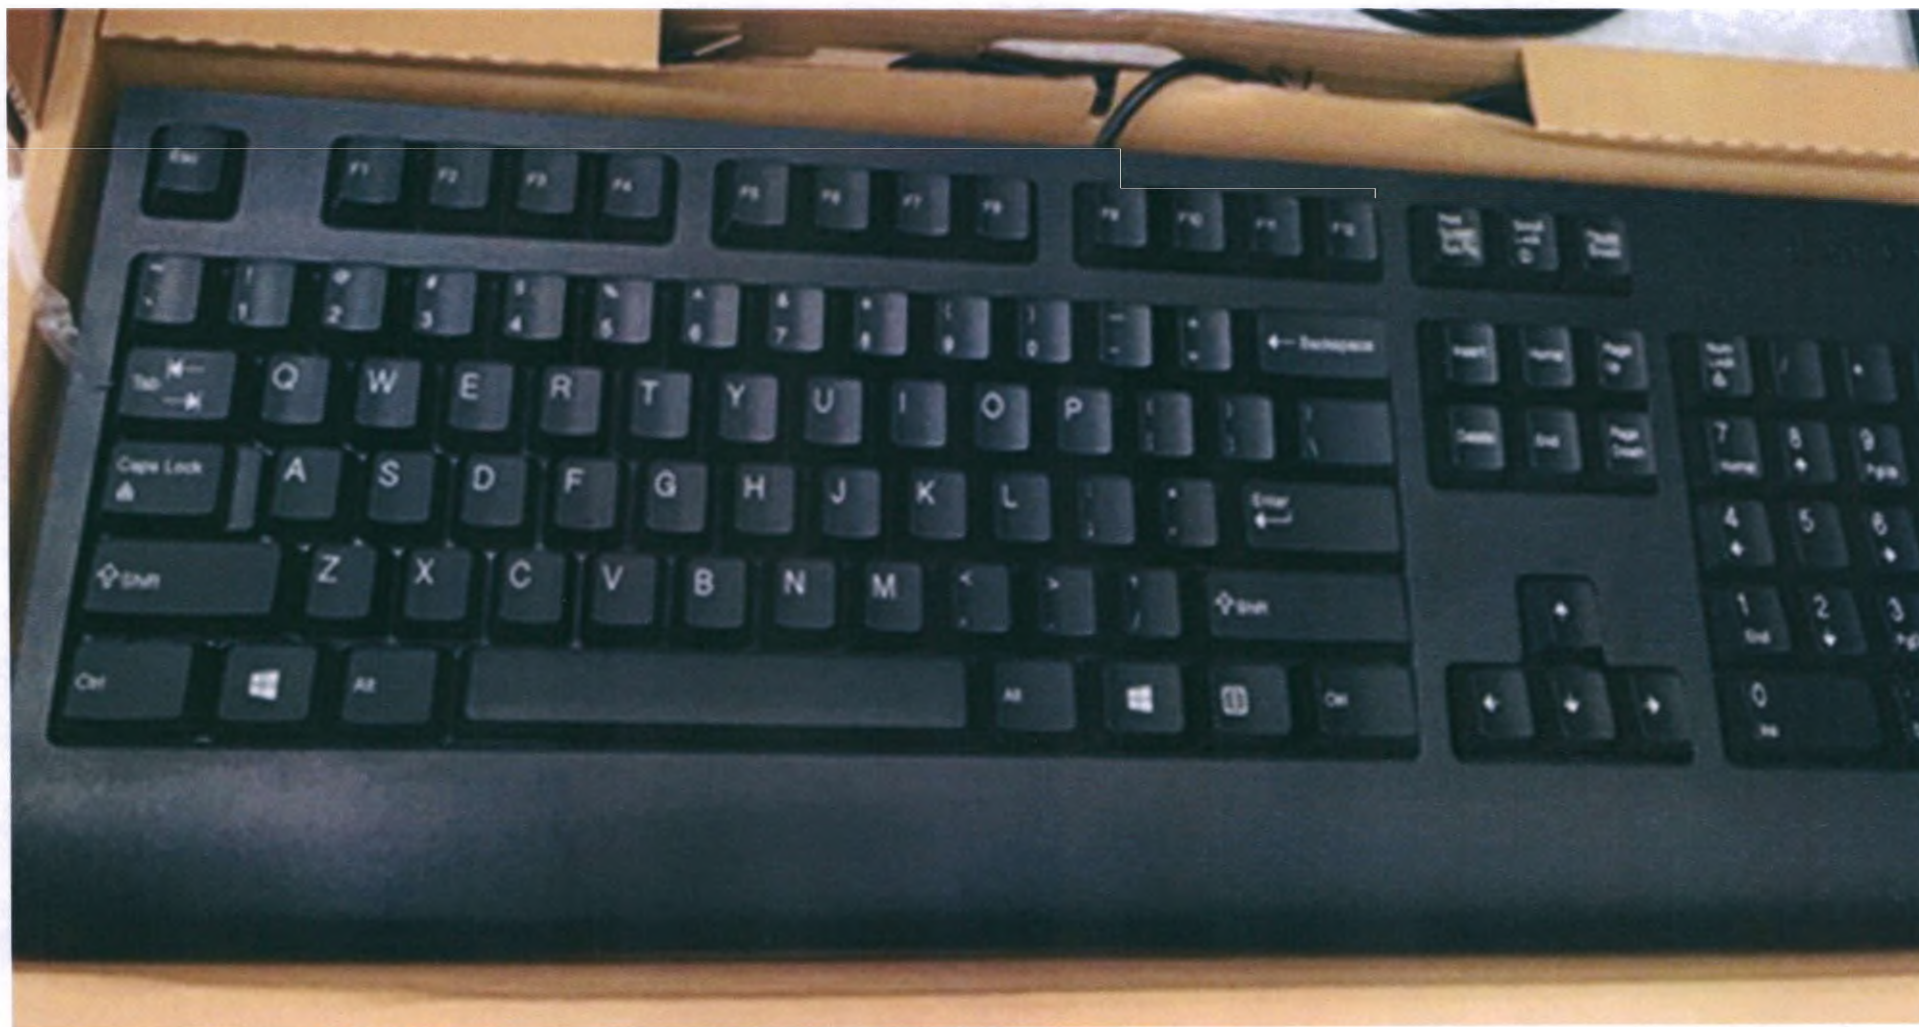

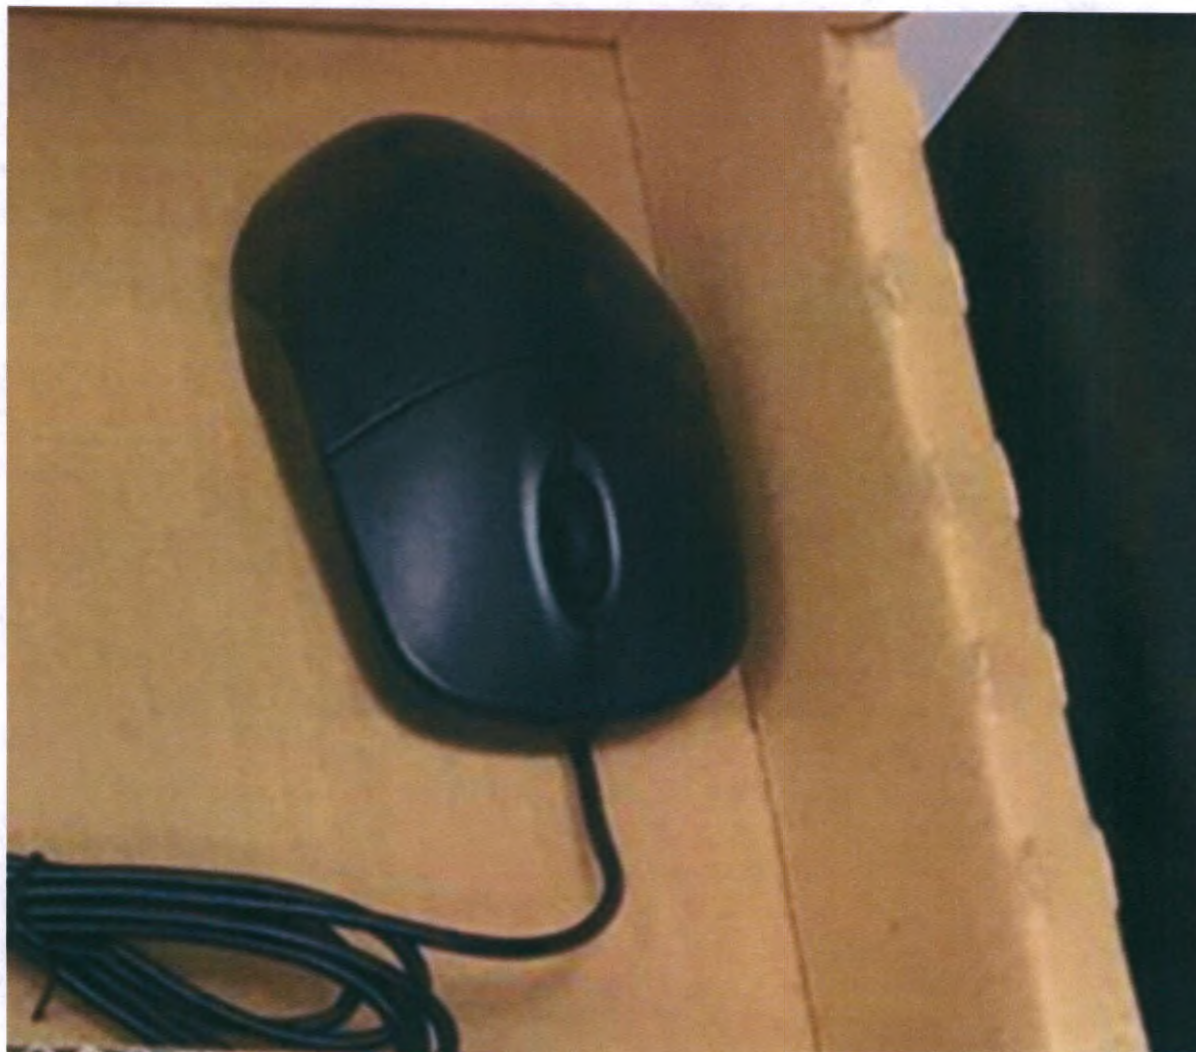



51. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоразовая NIBP, детская (оранжевая), 8-13 см



Манжета многоразовая NIBP, детская (зеленая), 12-19 см



Манжета многоразовая NIBP, маленькая, для взрослых (ярко-синяя), 17-25 см



Манжета многоразовая NIBP, для взрослых (серая), 23-33 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (серая), 28-40 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (бордовая), 40-55 см

51. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоцветная NIBP, набедренная (коричневая), 38-50 см

52. Кабель соединительный магистральный для ЭКГ, не более 6 шт.



53. Кабель для ЭКГ- отведений, не более 6 шт.






Кабель для датчика инвазивного измерения давления, длина 320 см



Красный коннектор кабеля-удлинителя IBP к разъему с надписью IBP на усилителе QMAPP.

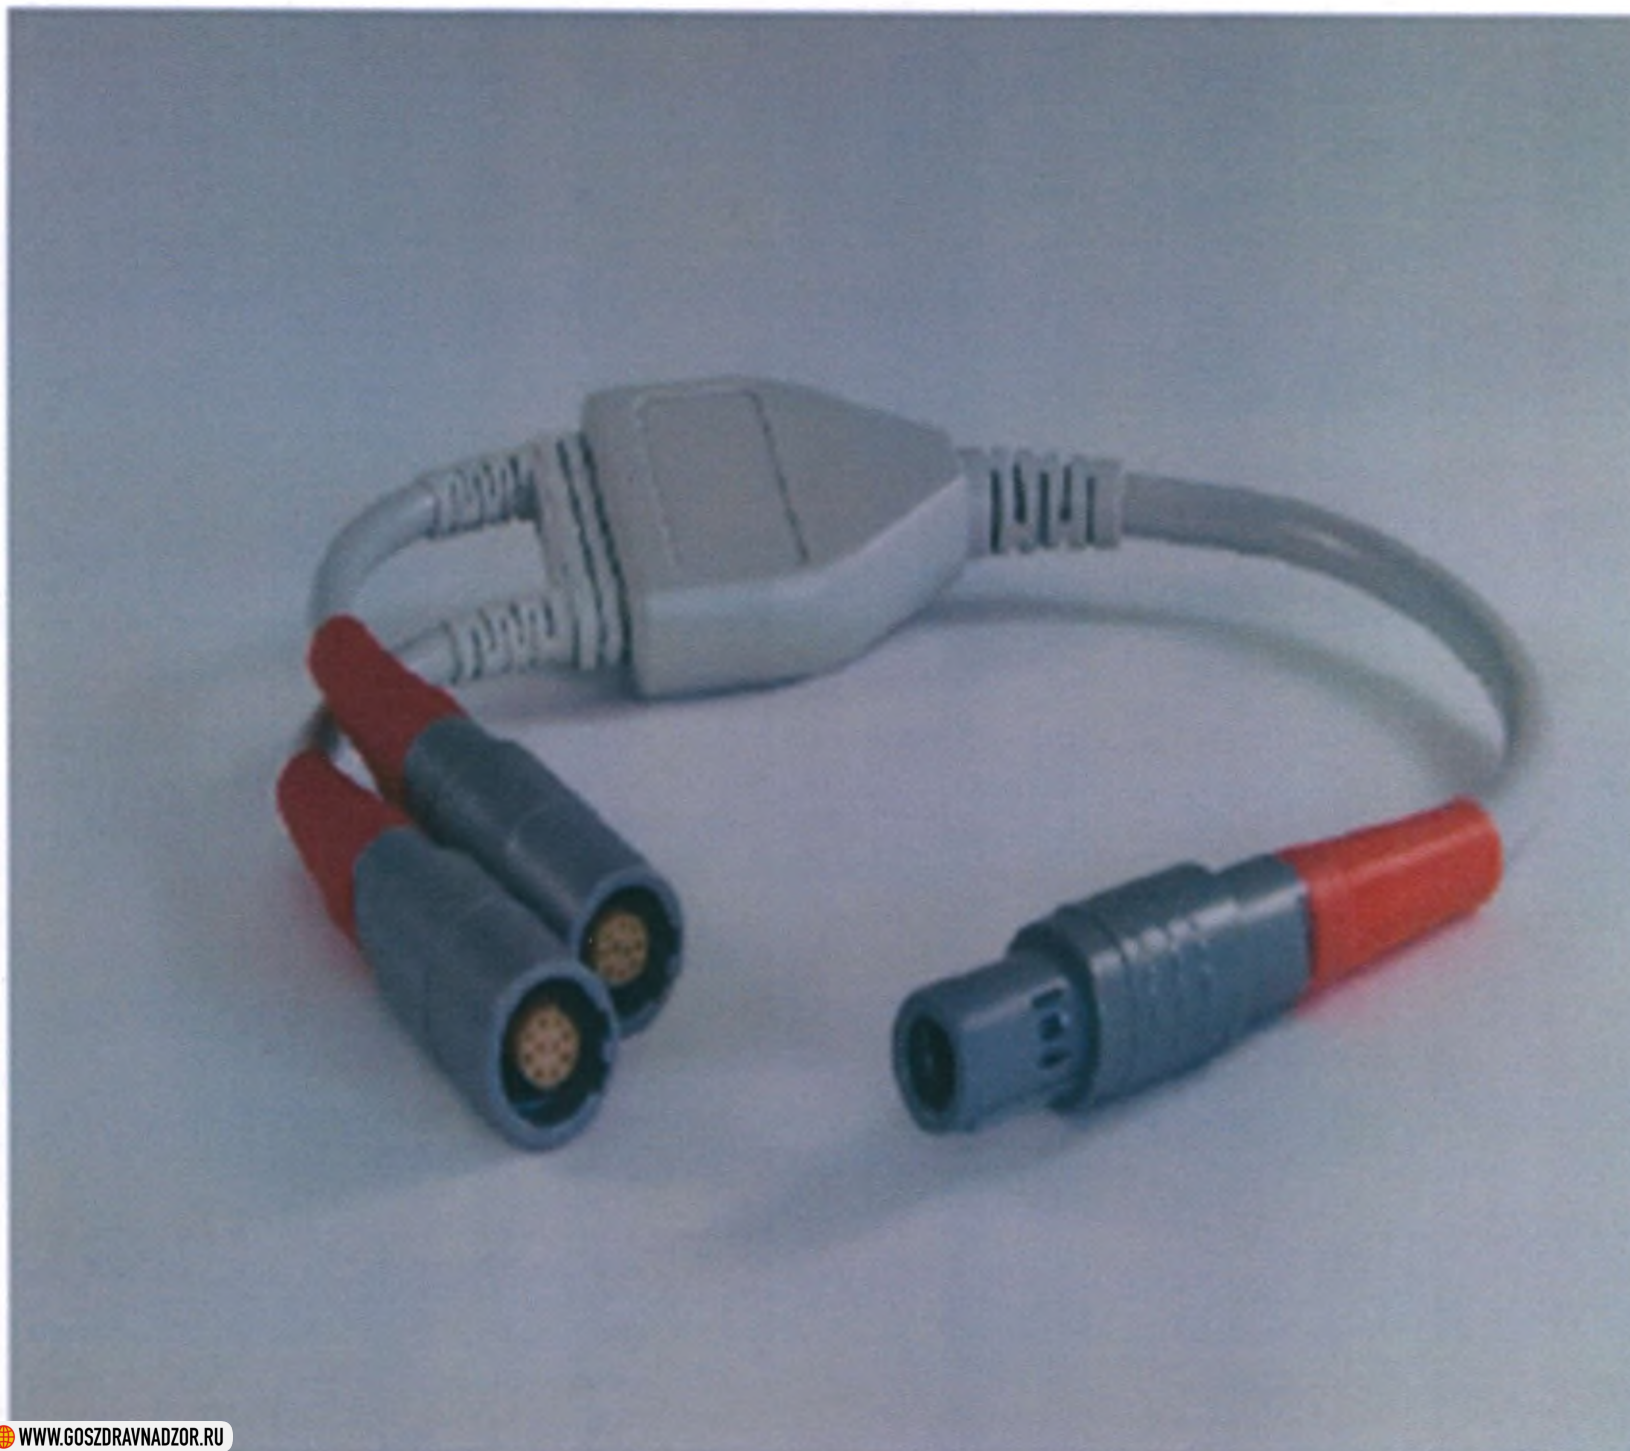

56. Модуль четырехканальный для ИВР.



57. Кабель соединительный для модуля ИВР, не более 6 шт.

290







60. Комплект для измерения сердечного выброса методом термоделиции, в составе:- кабель для измерения сердечного выброса методом термоделиции, не более 2 шт.;



60. Комплект для измерения сердечного выброса методом термоделиции, в составе:

- датчик для измерения сердечного выброса методом термоделиции, не более 2 шт.



61. Модуль для регистрации фракционного резерва кровотока.

FFR 

Mode: **Monitoring** ▼

Channel:

Pa
(AO pressure) ▼

Pd
(AOPd pressure wire) ▼

Averaging: **Short** ▼

Equalize

Record FFR

FFR 

Mode: **Measurement** ▼

Channel:

Pa
(AO pressure) ▼

Pd
(AOPd pressure wire) ▼

Averaging: **Middle** ▼

Equalize

Record FFR

62. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.



Кабель типа 6.3 мм «Моно Jack» для «Volcano i5», длина 320 см



Кабель для регистрации давления для «Volcano», длина 320 см




Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:



Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:

Кабель Pd к Boston

62. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.

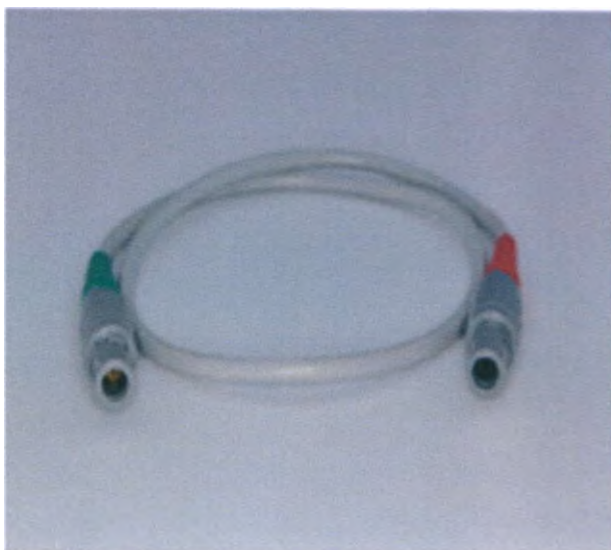

кабель Abbot длиной 65 см






кабель Abbot длиной 320 см





кабель для Abbot Wibox длиной 320 см


63. Блок для регистрации фракционного резерва кровотока

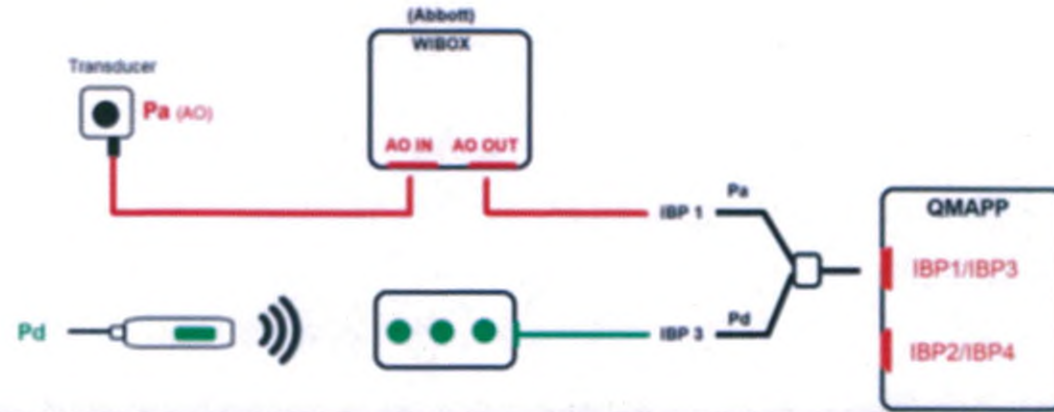


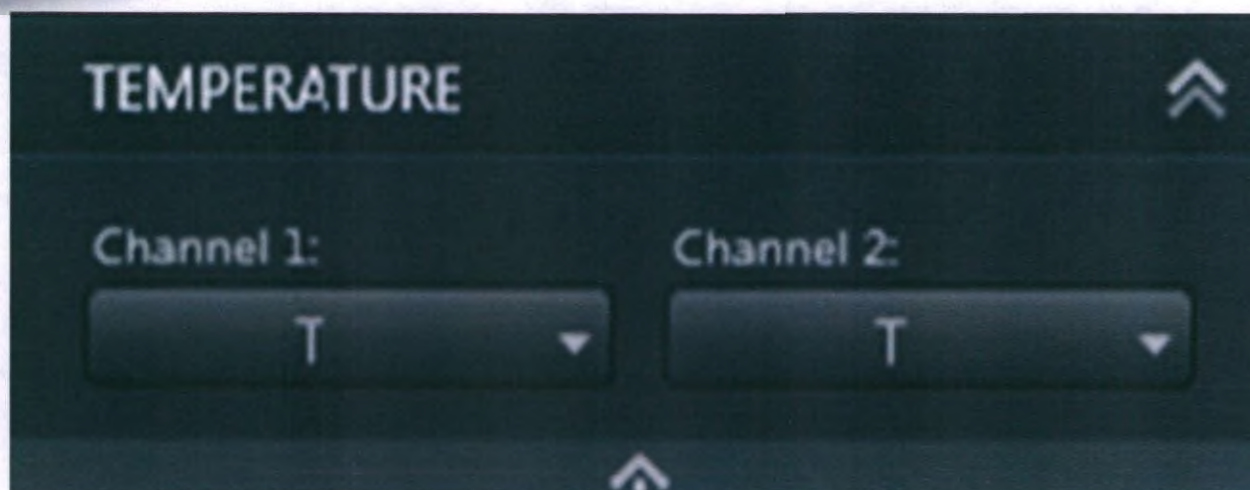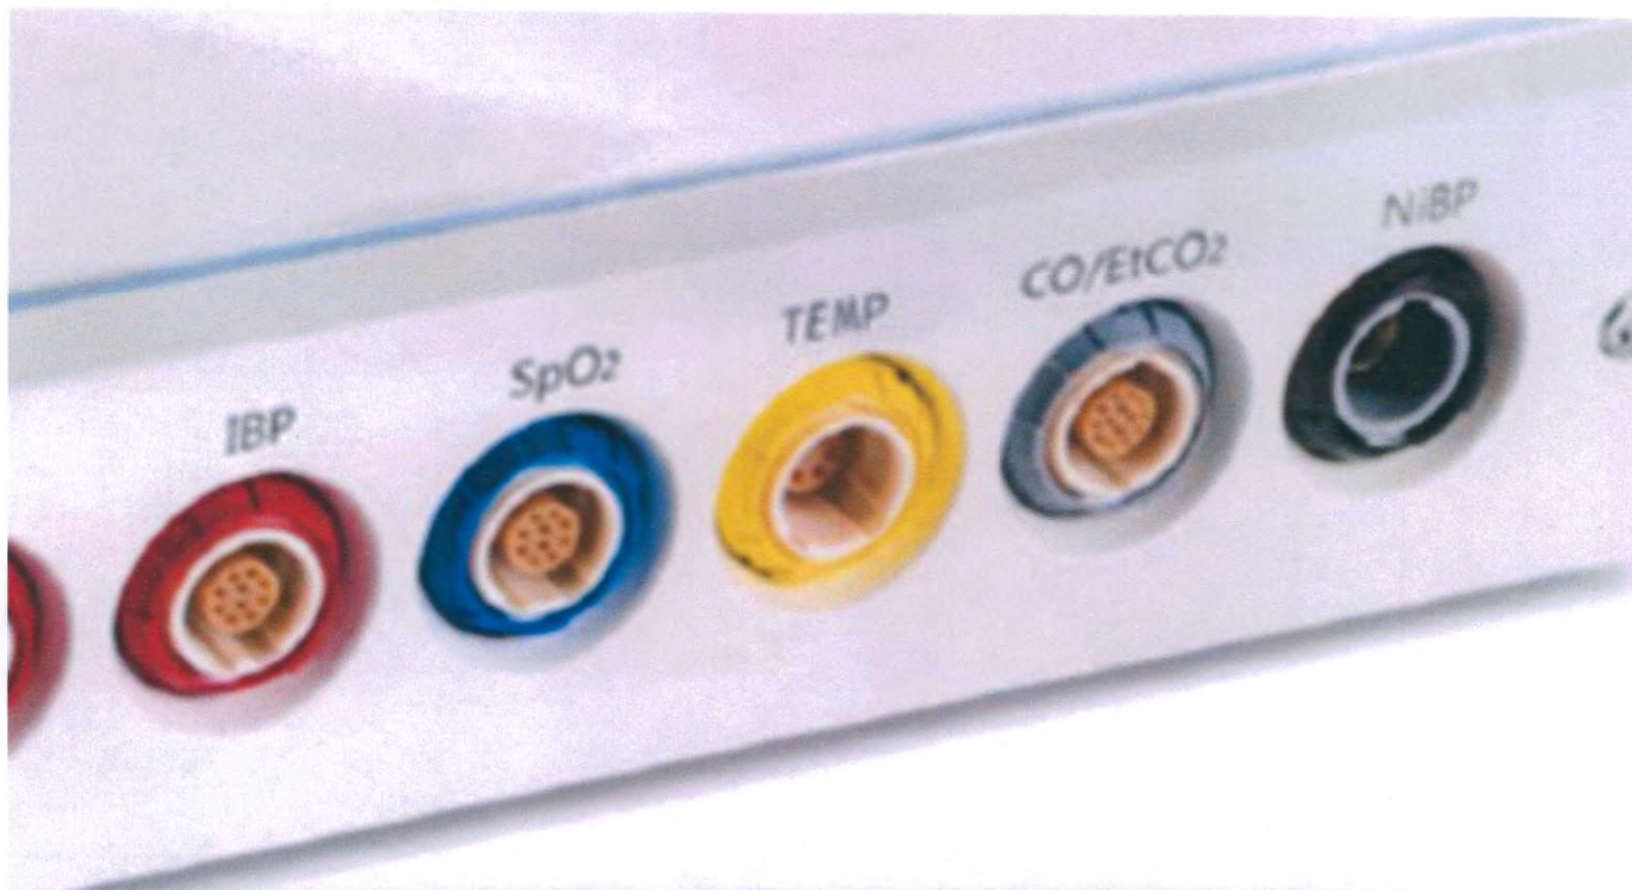




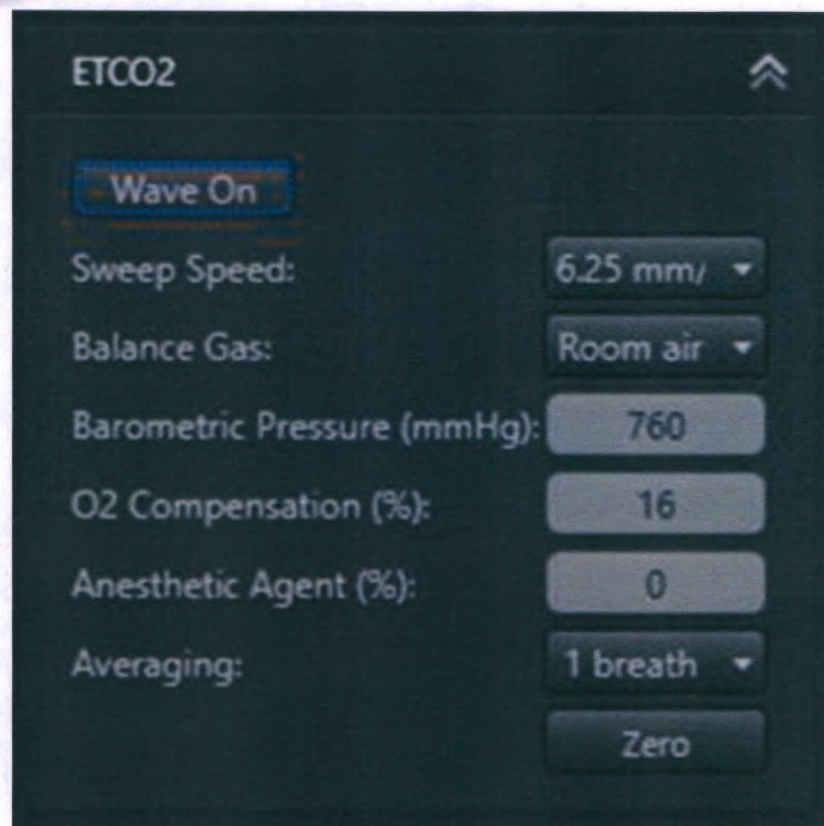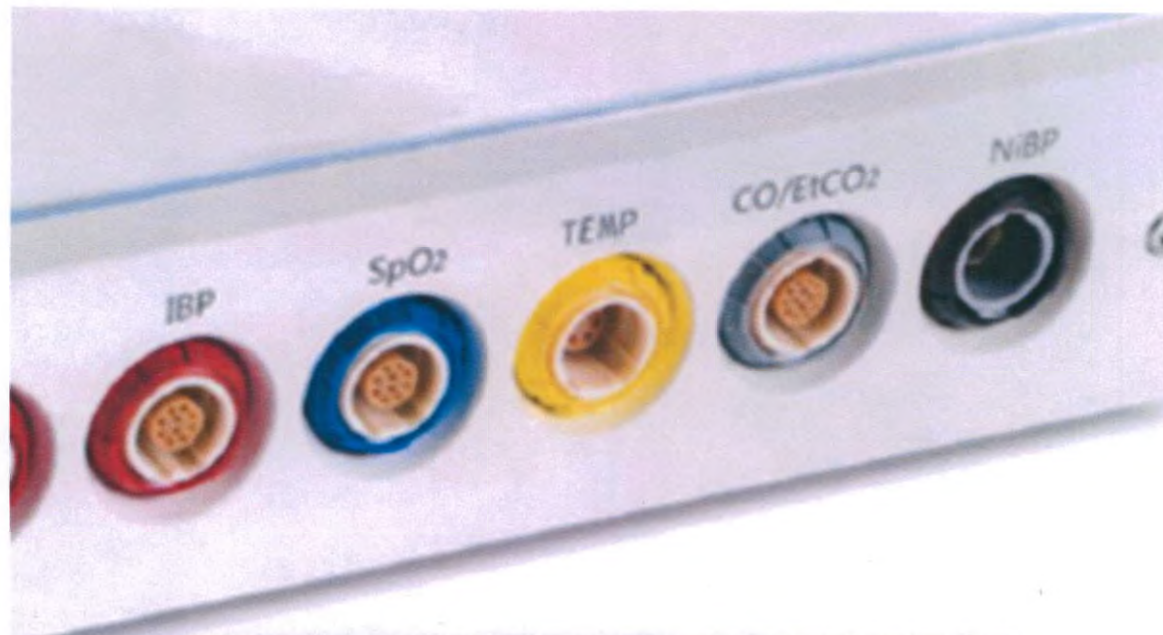

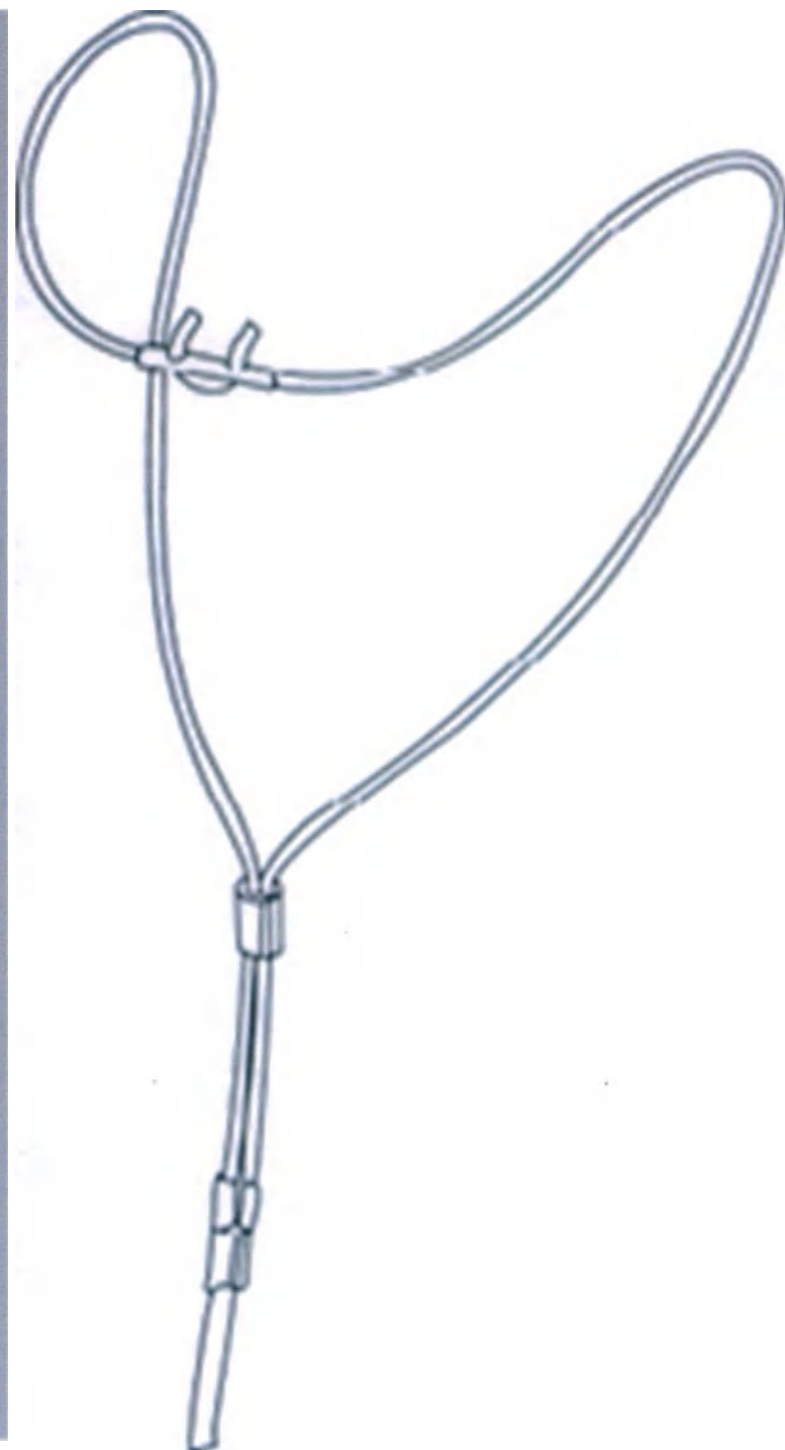

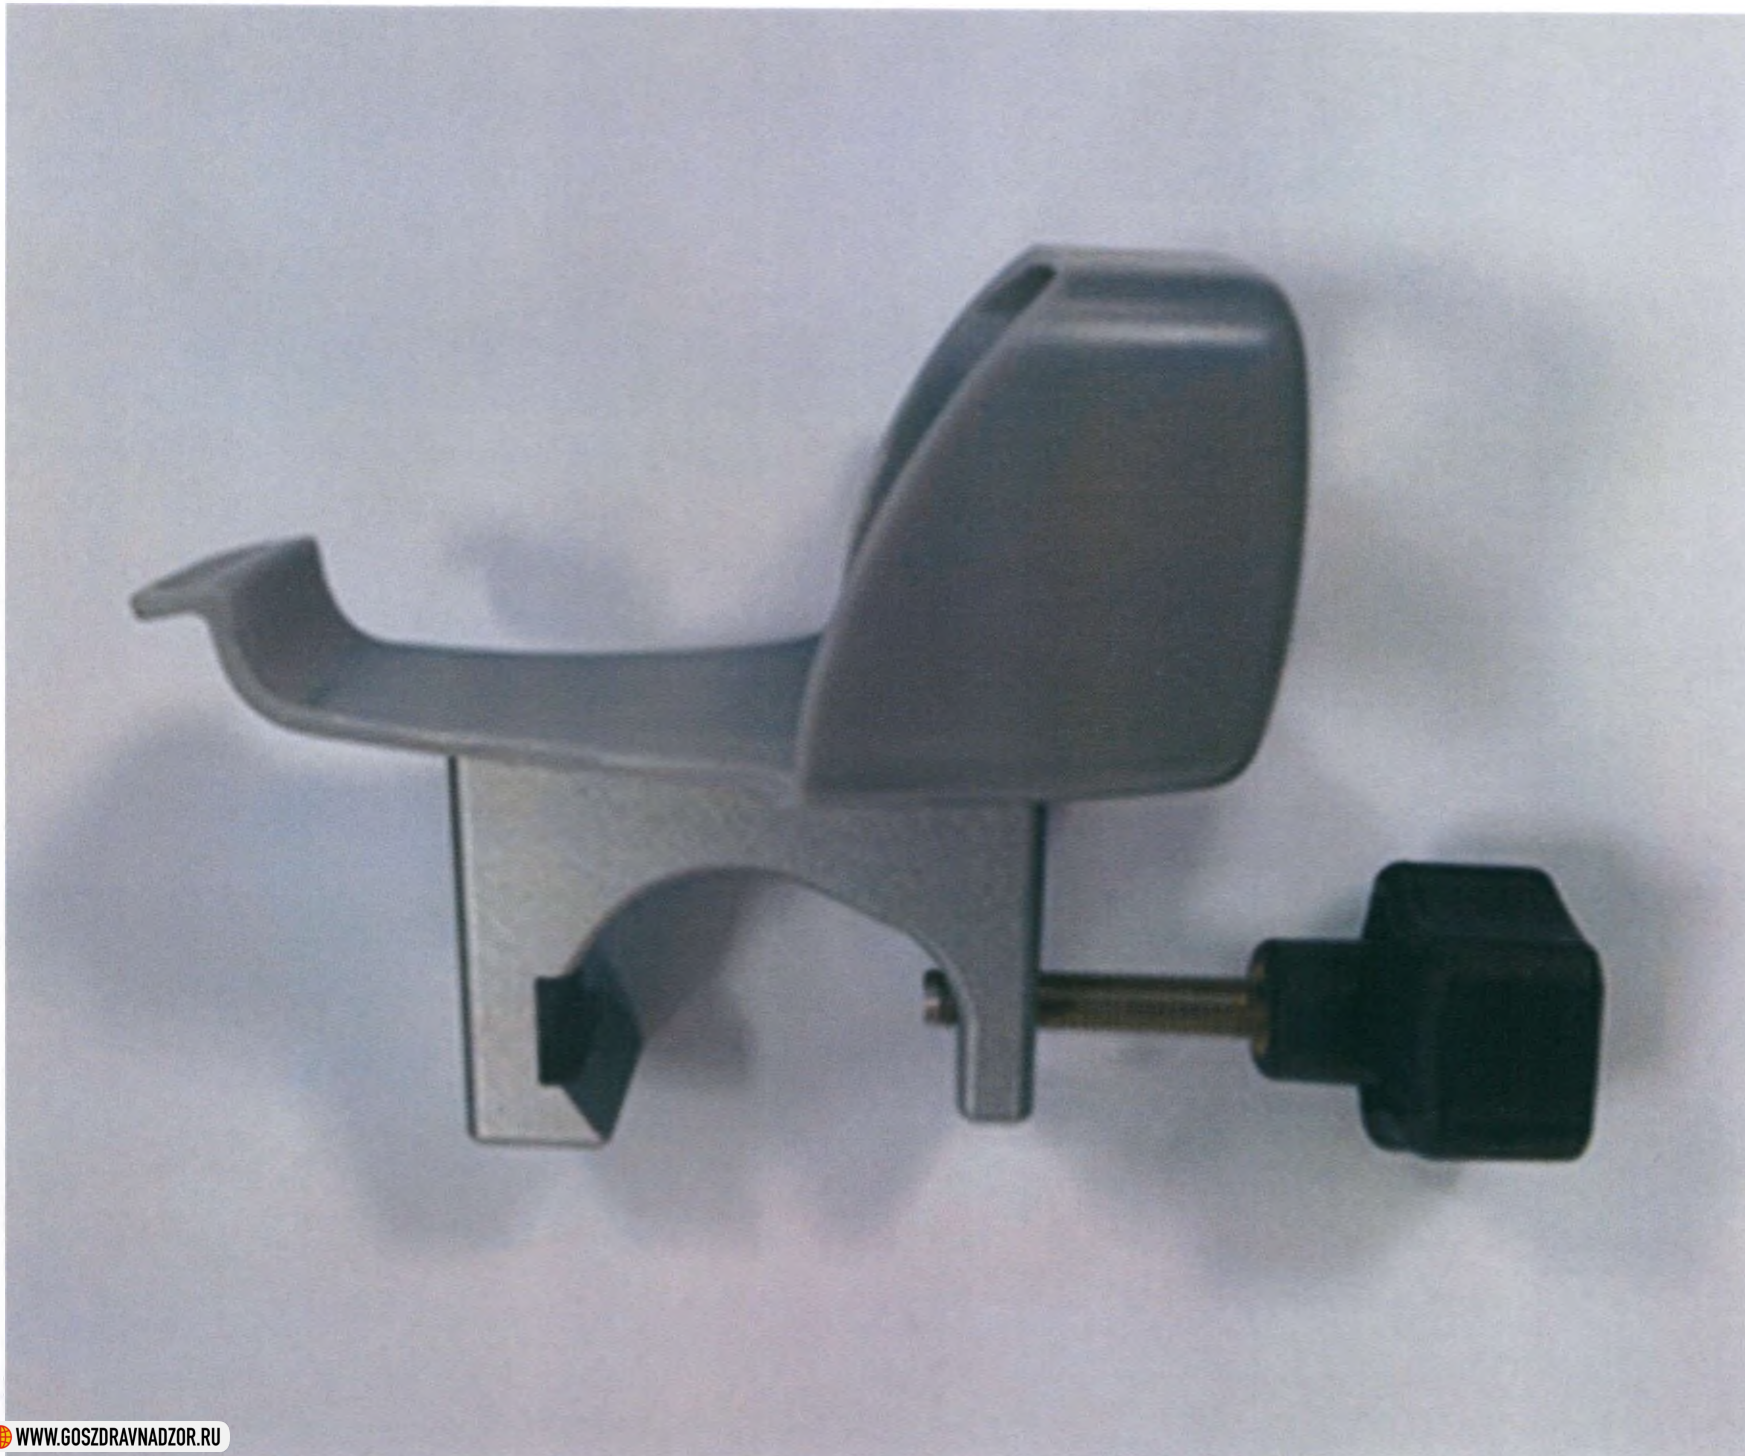

69. Датчик температурный, не более 5 шт.

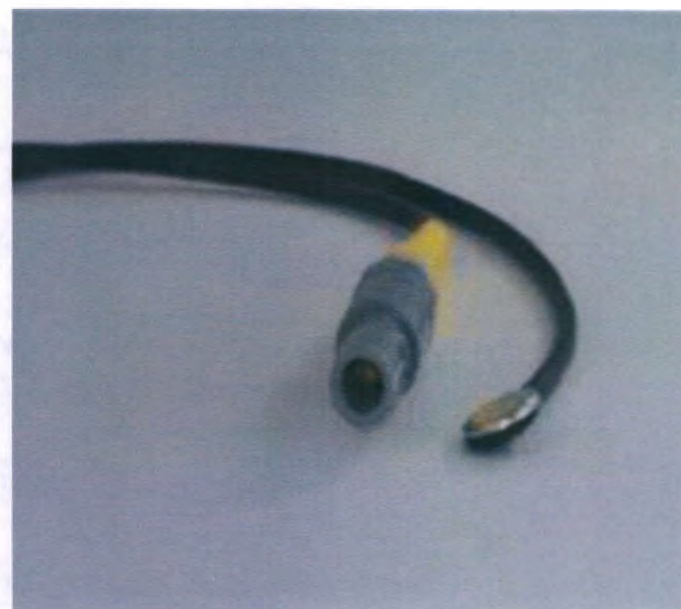

Датчик кожный, многоразовый для взрослых



Датчик ректальный многоразовый для взрослых.

69. Датчик температурный, не более 5 шт.

303




Датчик центральный многоразовый для взрослых

70. Кабель соединительный для температурных датчиков, не более 3 шт.



71. Кабель для выходного сигнала AUX, не более 3 шт.

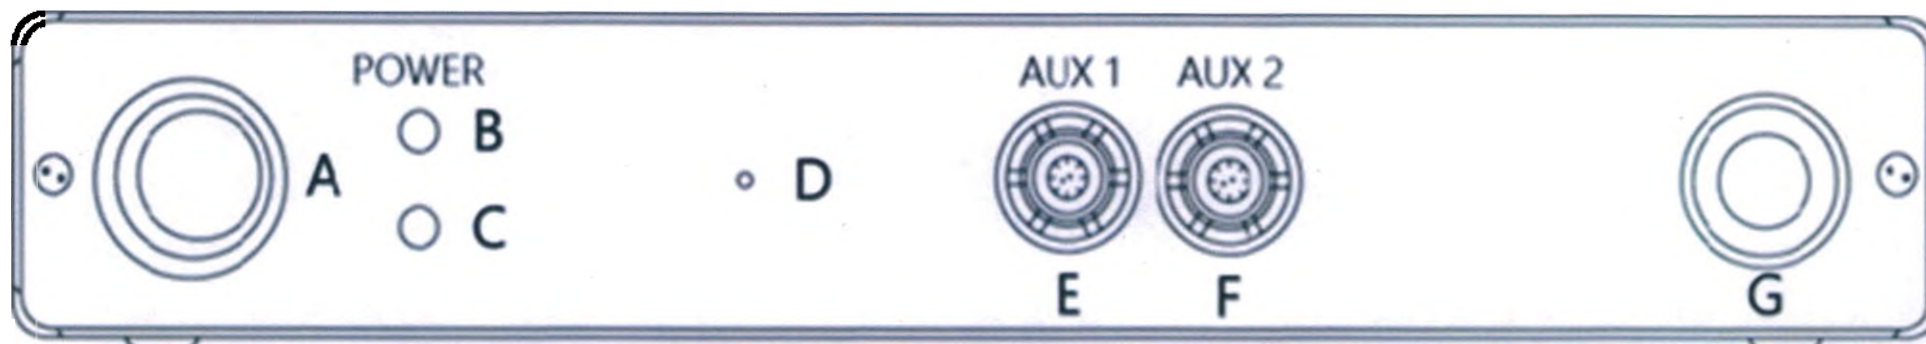




73. Датчик многоразовый SpO₂, не более 3 шт.



74. Кабель для неинвазивного измерения давления, не более 3 шт.



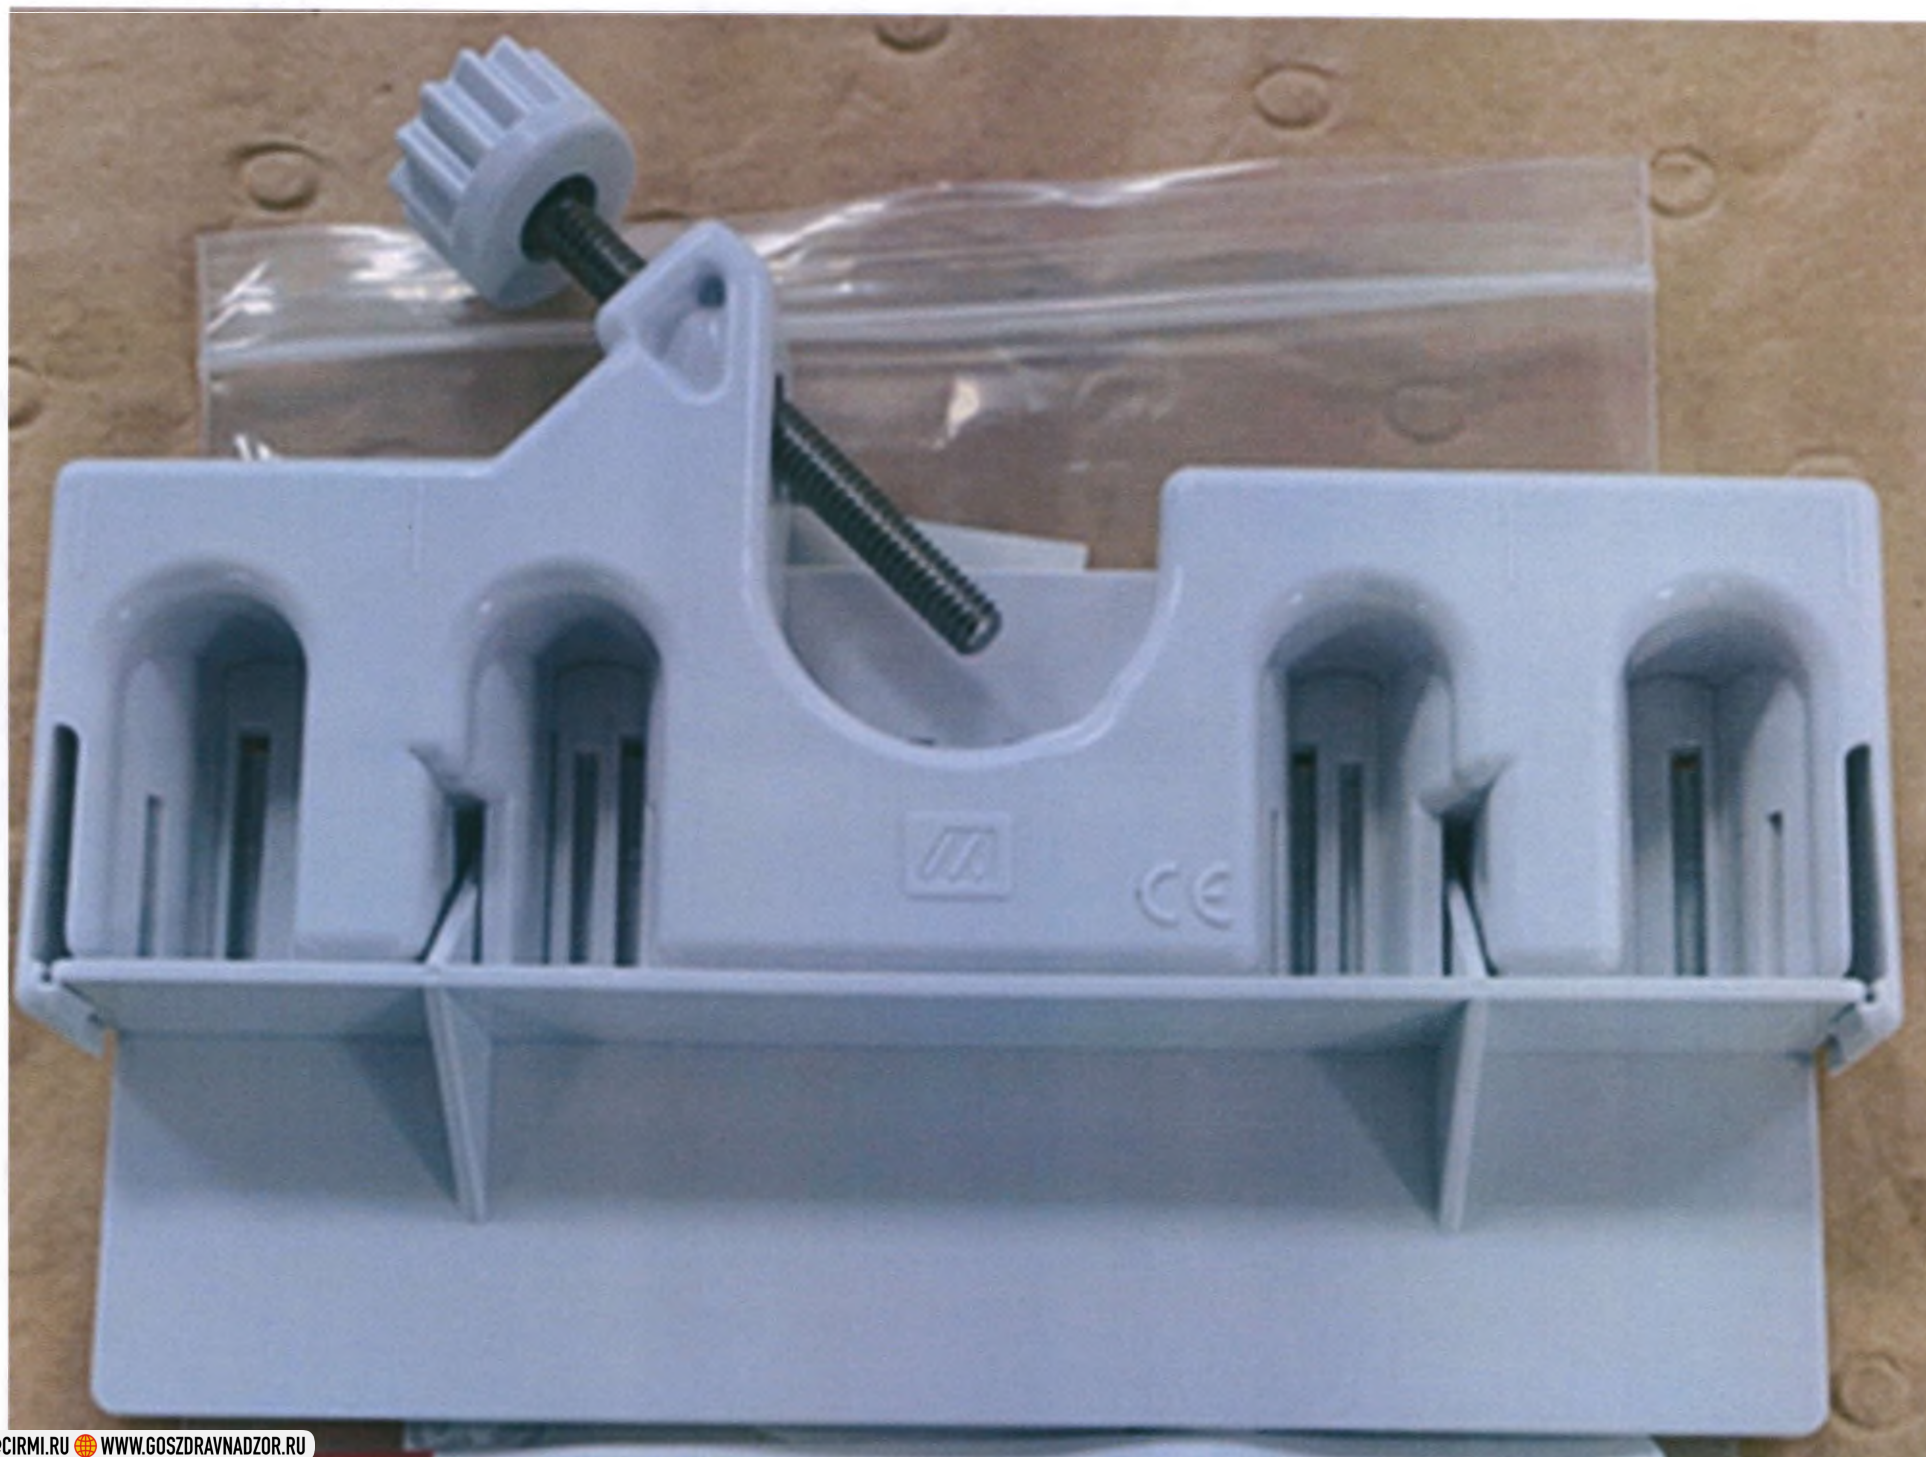

76. Комплект для вывода внешнего сигнала.





78. Консоль для просмотра изображений.



79. Монитор с большим экраном (для цифрового вывода, 48 портов).




Монитор



Многоэкранный сетевой компоновщик



Сенсорный интерфейс пользователя

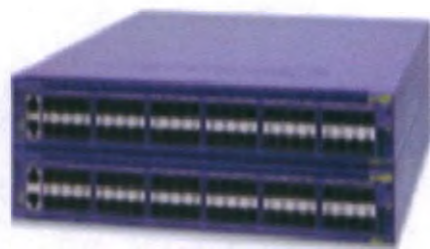

Коммутатор Summit x670-48x



Кодировщик MNA-120ENC-DVI

80. Цифровое кодирующее устройство для добавления двух входных каналов DVI.



81. Комплект принадлежностей для большого монитора (система видеопередачи для операционной).



Подставка



Передатчик DVI 1




Передатчик DVI 2




Блок питания для монитора с большим экраном



Сетевой концентратор

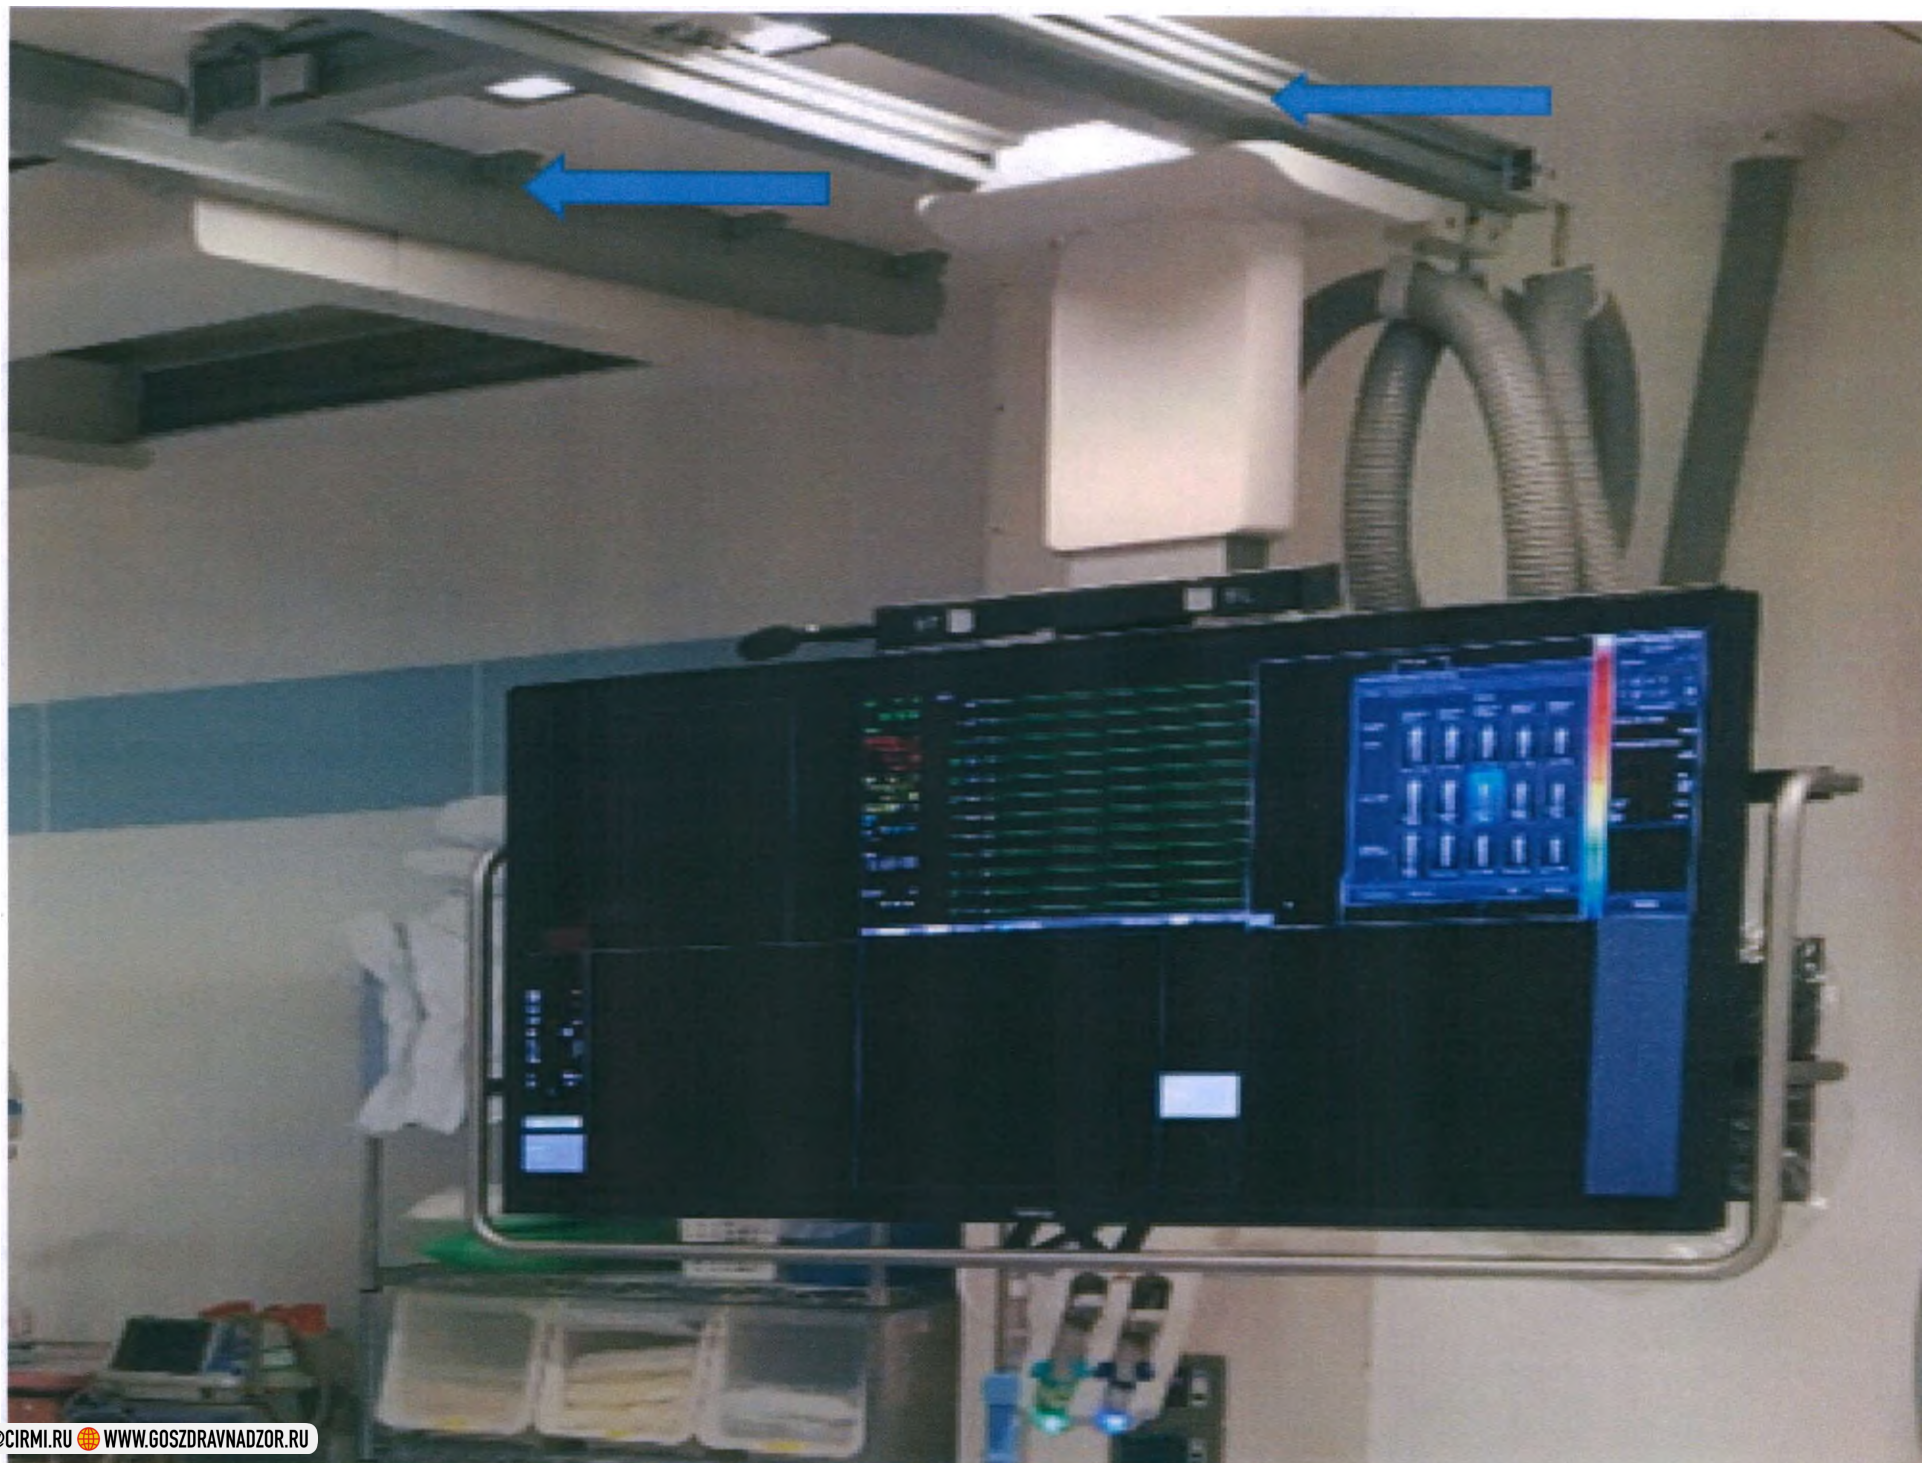


83. Комплект для защиты от магнитных полей (магнитный экран), в вариантах исполнения: - для FPD 12х16 дюймов;

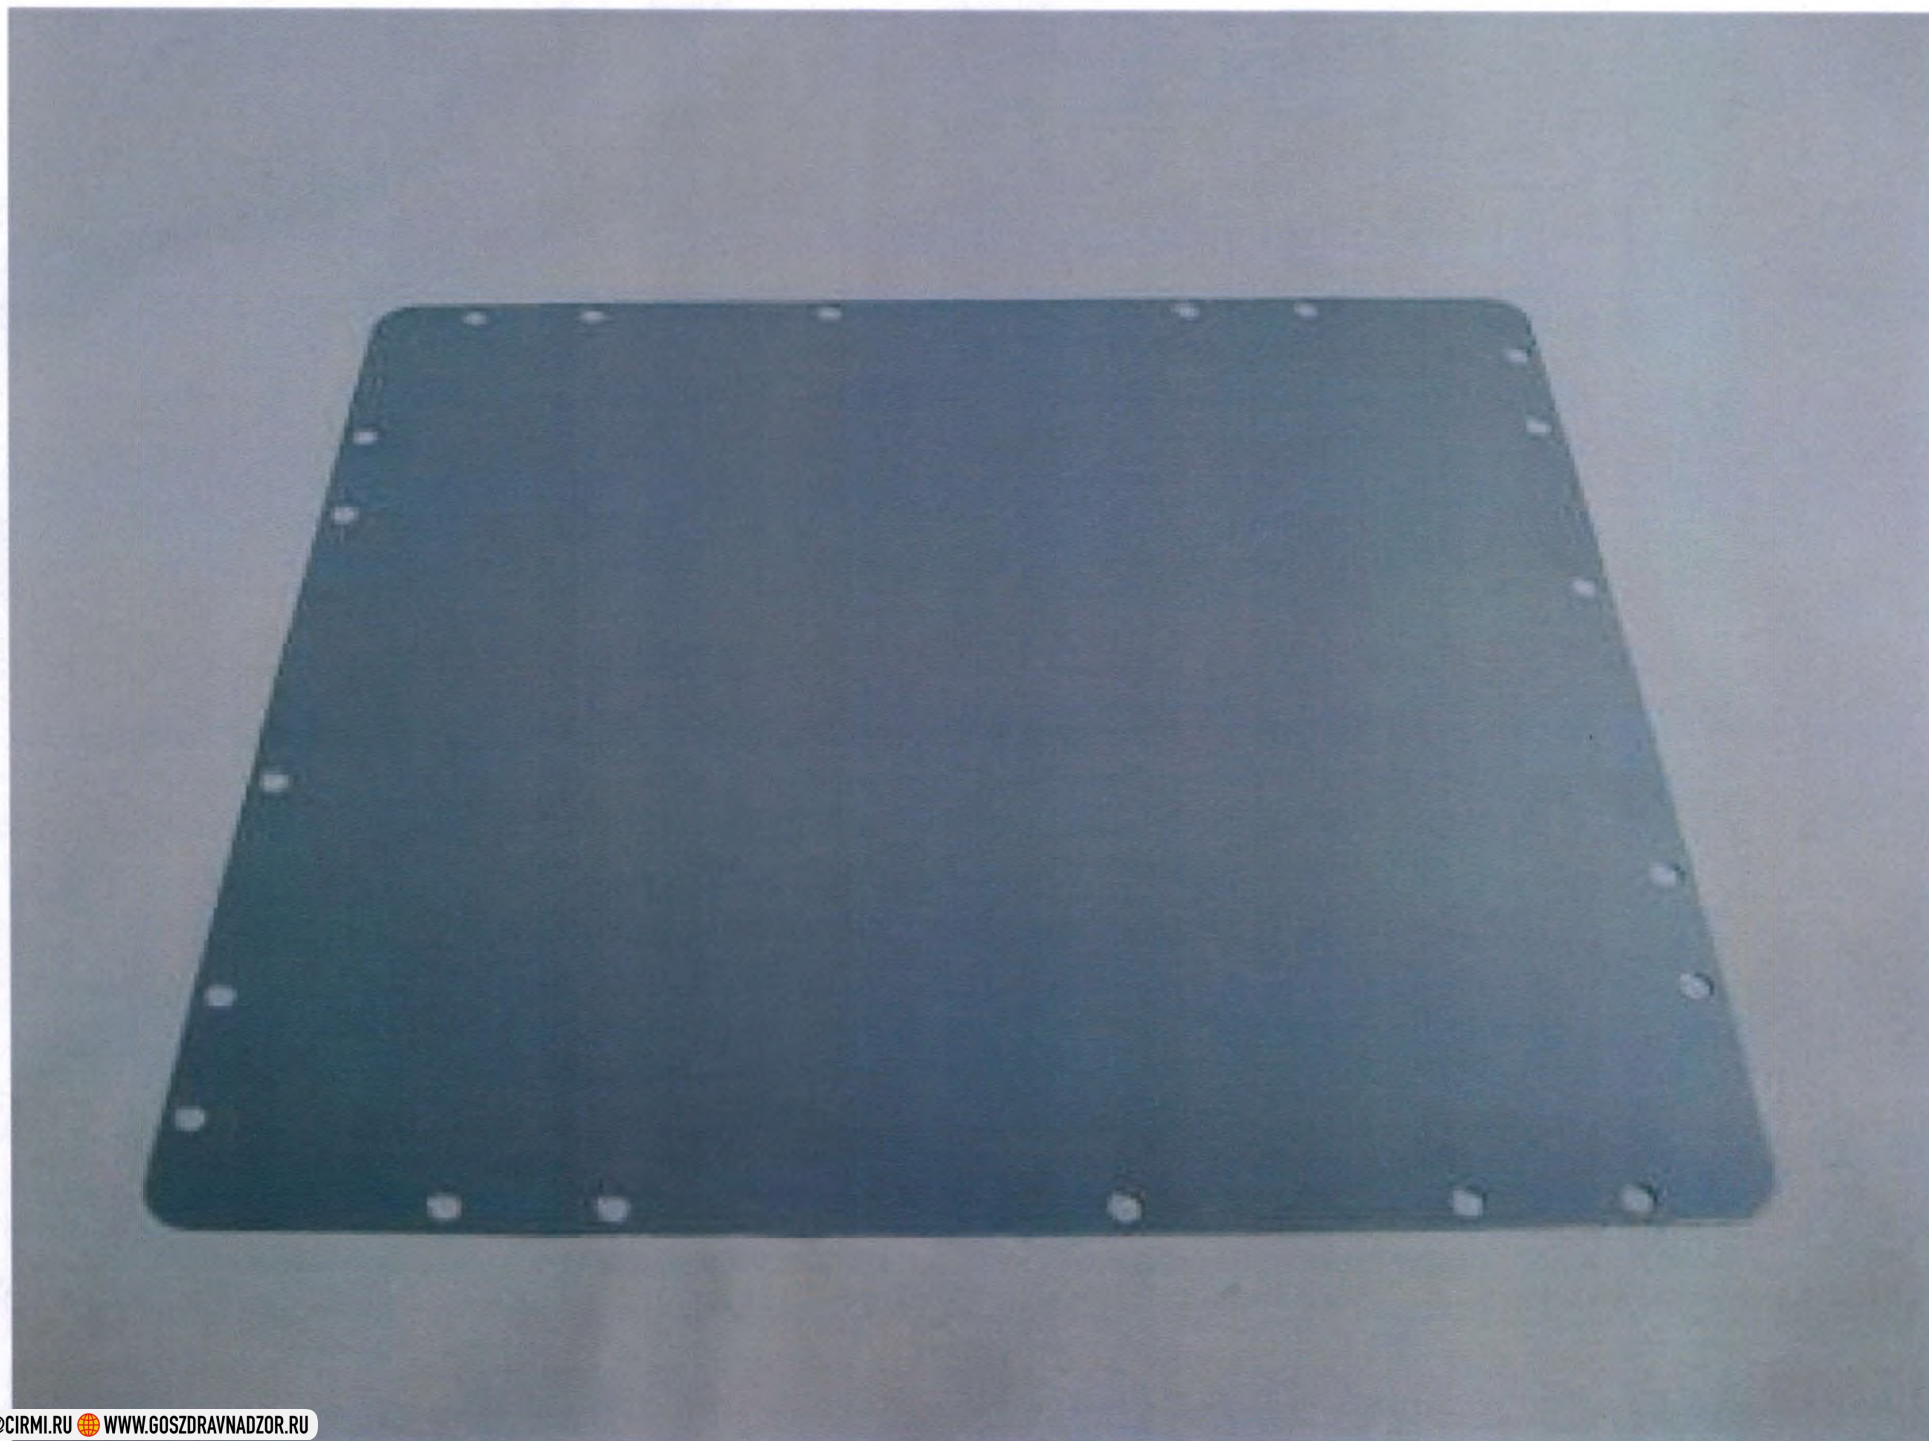


83. Комплект для защиты от магнитных полей (магнитный экран), в вариантах исполнения: - для 12-дюймового FPD.

300

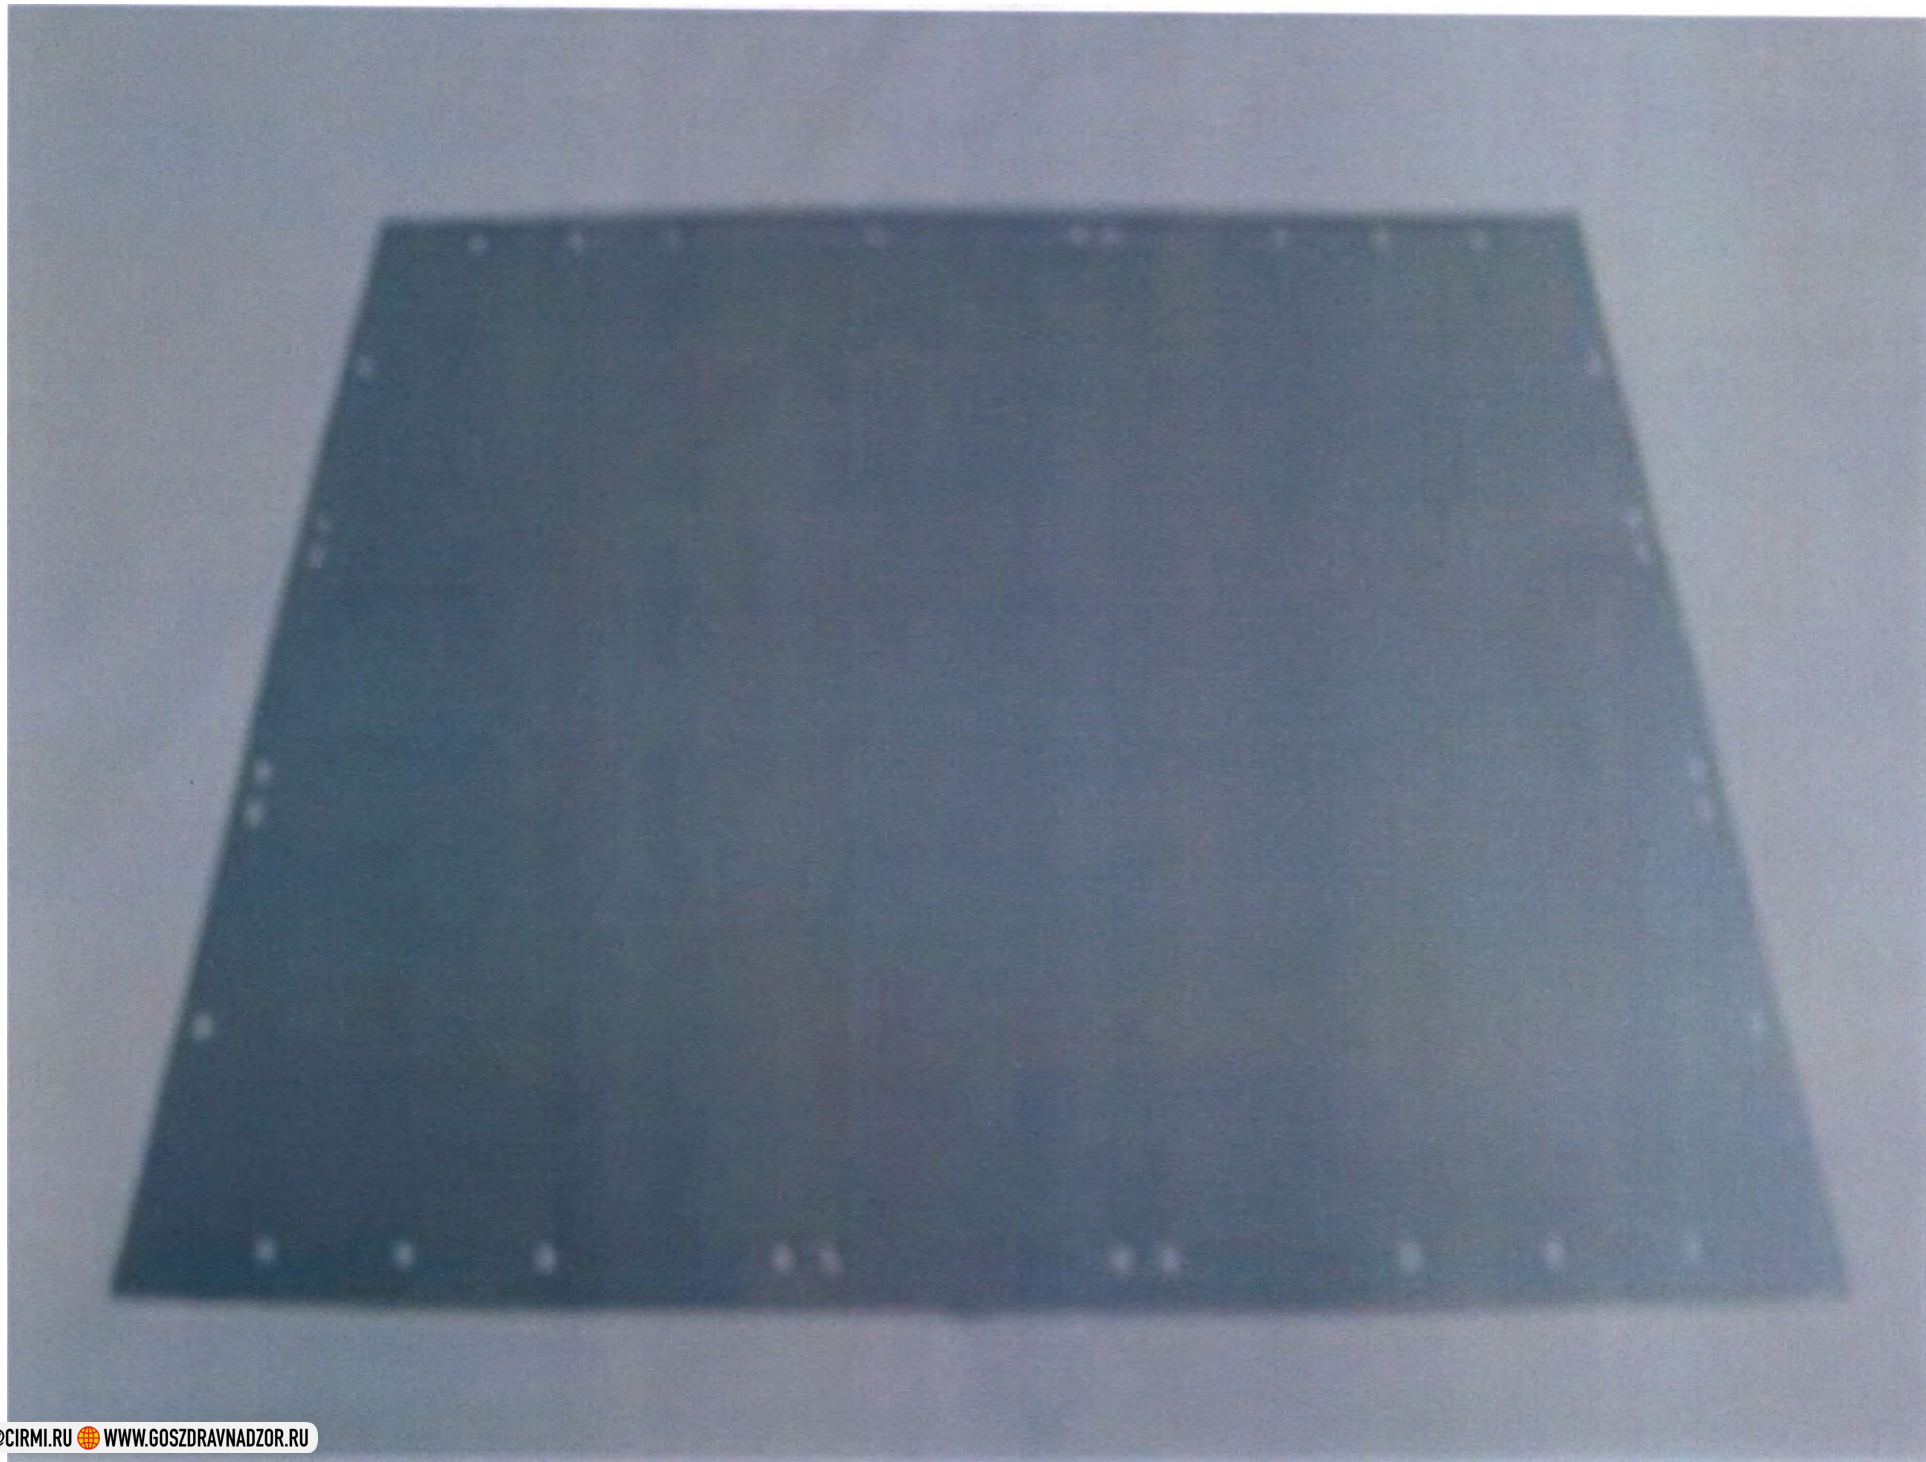


84. Комплект фиксатора поворота опорной колонны (для CAS-880A)

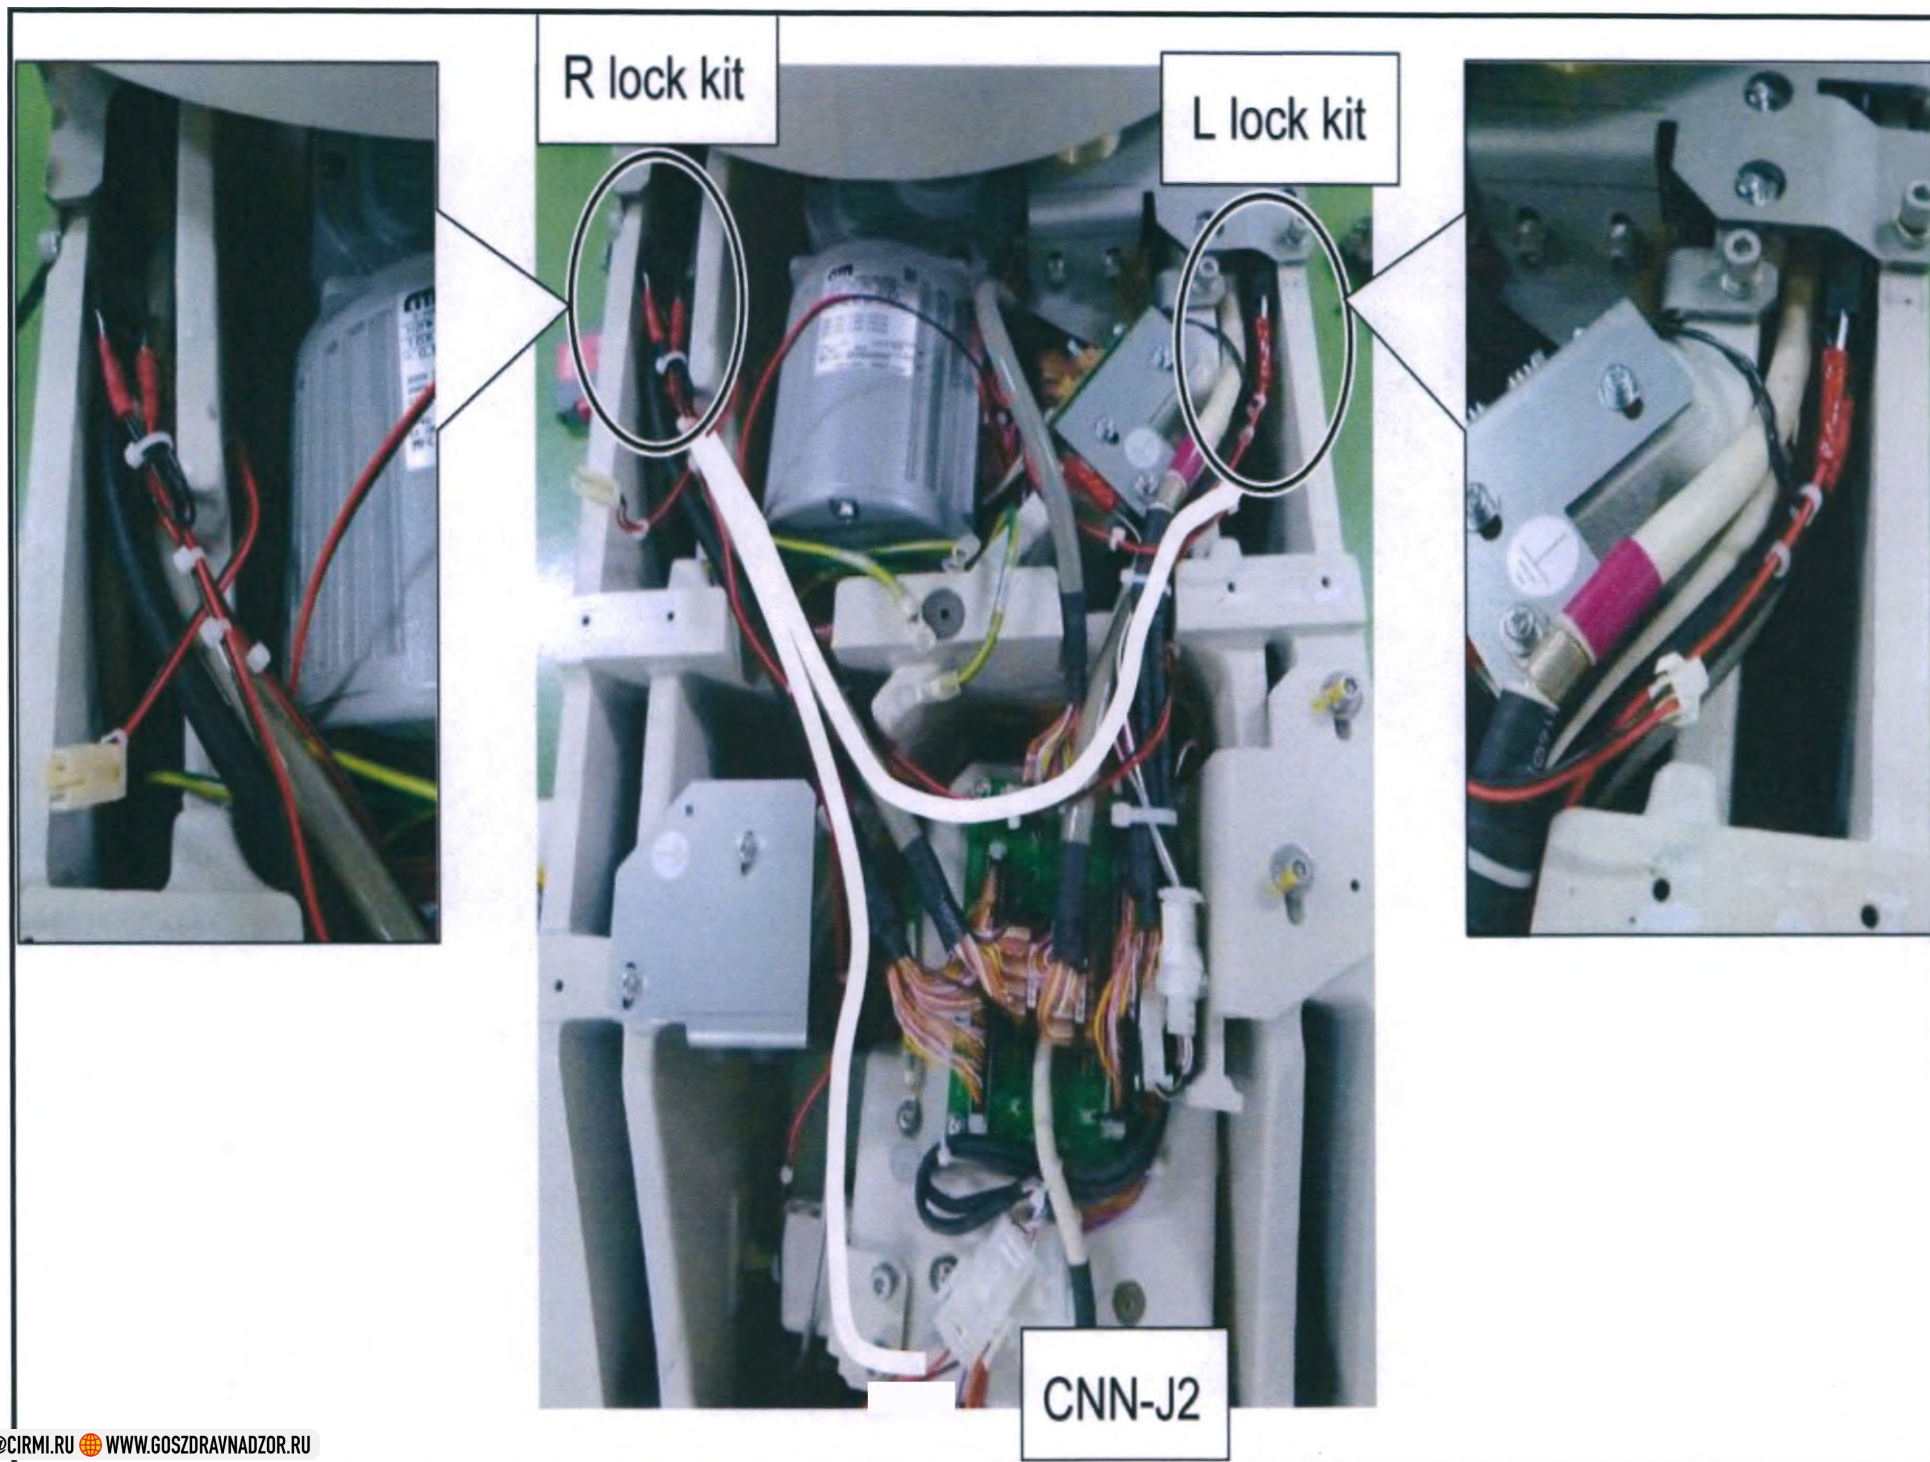

85. Датчик продольного перемещения (для CAT-850B).



Комплект встроен
внутрь
CAT-850B/B1

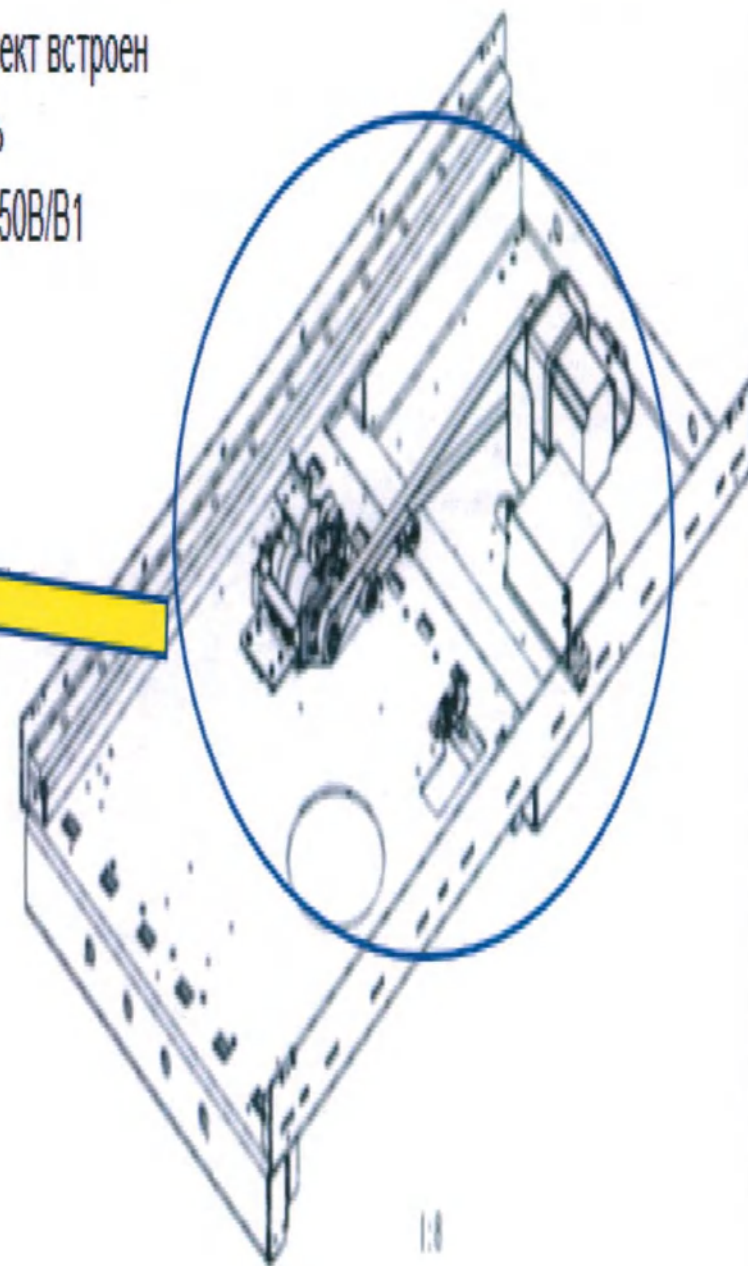

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - программное обеспечение основное - 1 шт.

Study List

Search: Searching default archive for Modality Any Study Date Any Status Any

Filter By: Patient ID, Patient Name, Date of Birth, Accession Number, Study Description, Modality, Study Date

Station	Patient Name	Patient ID	Sex	Modality	# Images	Study Date/Time	Accession #	Study Description
	Embolication Plan	20240408	F	CT	762	08 Apr 2024 09:17		
	ROCT SACRAL VERTEBROPLASTY	0A2V-003	F	CT	3238	24 Mar 2024 13:05	VISION	
	CHEST CT/PE, SURE VV	0A2V-TU...	F	CT	2503	07 Feb 2024 17:09	CHE_VISION	
	CHEST CT/PE, SURE VV	0A2V-TU...	F	CT	2475	05 Feb 2024 22:24	CHE_VISION	
	CHEST CT/PE, SURE VV	0A2V-TU...	F	CT	3204	05 Feb 2024 13:08	CHE_VISION	
	DSA HEAD 151	3D-INFX...		XA, SB	1627	18 Dec 2013 07:29		INFX
	LC BODY 066	LC-INFX...		XA, SB	1542	25 Aug 2013 13:36		INFX
	LC BODY 068	LC-INFX...		XA	364	25 Aug 2013 09:58		INFX
	CAA	8501777	M	XA	1624	08 Aug 2013 06:16	2013040186...	
	MARCA			CT	1407	01 May 2013 14:28		CTA
	VALVE MELODY	12345		CT	6402	01 May 2013 12:54		Card Care CTA
	Bran COW Subtraction	MCA An...	F	CT, SB	722	01 Apr 2013 20:58	CHE_VISION	CT Angiogram C...
	MRA AD PULM	12377		MR	124	18 Mar 2013 06:01		Card Care Pulm...
	CEREBRAL ANEURYSM	3D-INFX-082		XA	513	11 Jun 2024 14:07	ABC	
	ST ABD RENALS CEMRA ENR PATH ROY SPN	148-CE...	M	MR	1136	05 May 2014 15:20		
	3D DSA L-Vert-Aneurysm 303	3D DSA...	F	XA	1025	18 Feb 2014 07:06		
	3D DSA LICA Aneurysm 012	3D DSA...	F	XA	512	27 Jan 2014 08:02		

Last updated: 32m ago Total results: 10

Applications: Research Study

3D 3D Volume 513 Cerebral Aneurysm Analysis Embolication Plan

CEREBRAL ANEURYSM | 3D-INFX-082 | 11 Jun 2024 14:07


Tools List Images

Open

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - персональный компьютер - 1 шт.




86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - клавиатура - 1 шт.

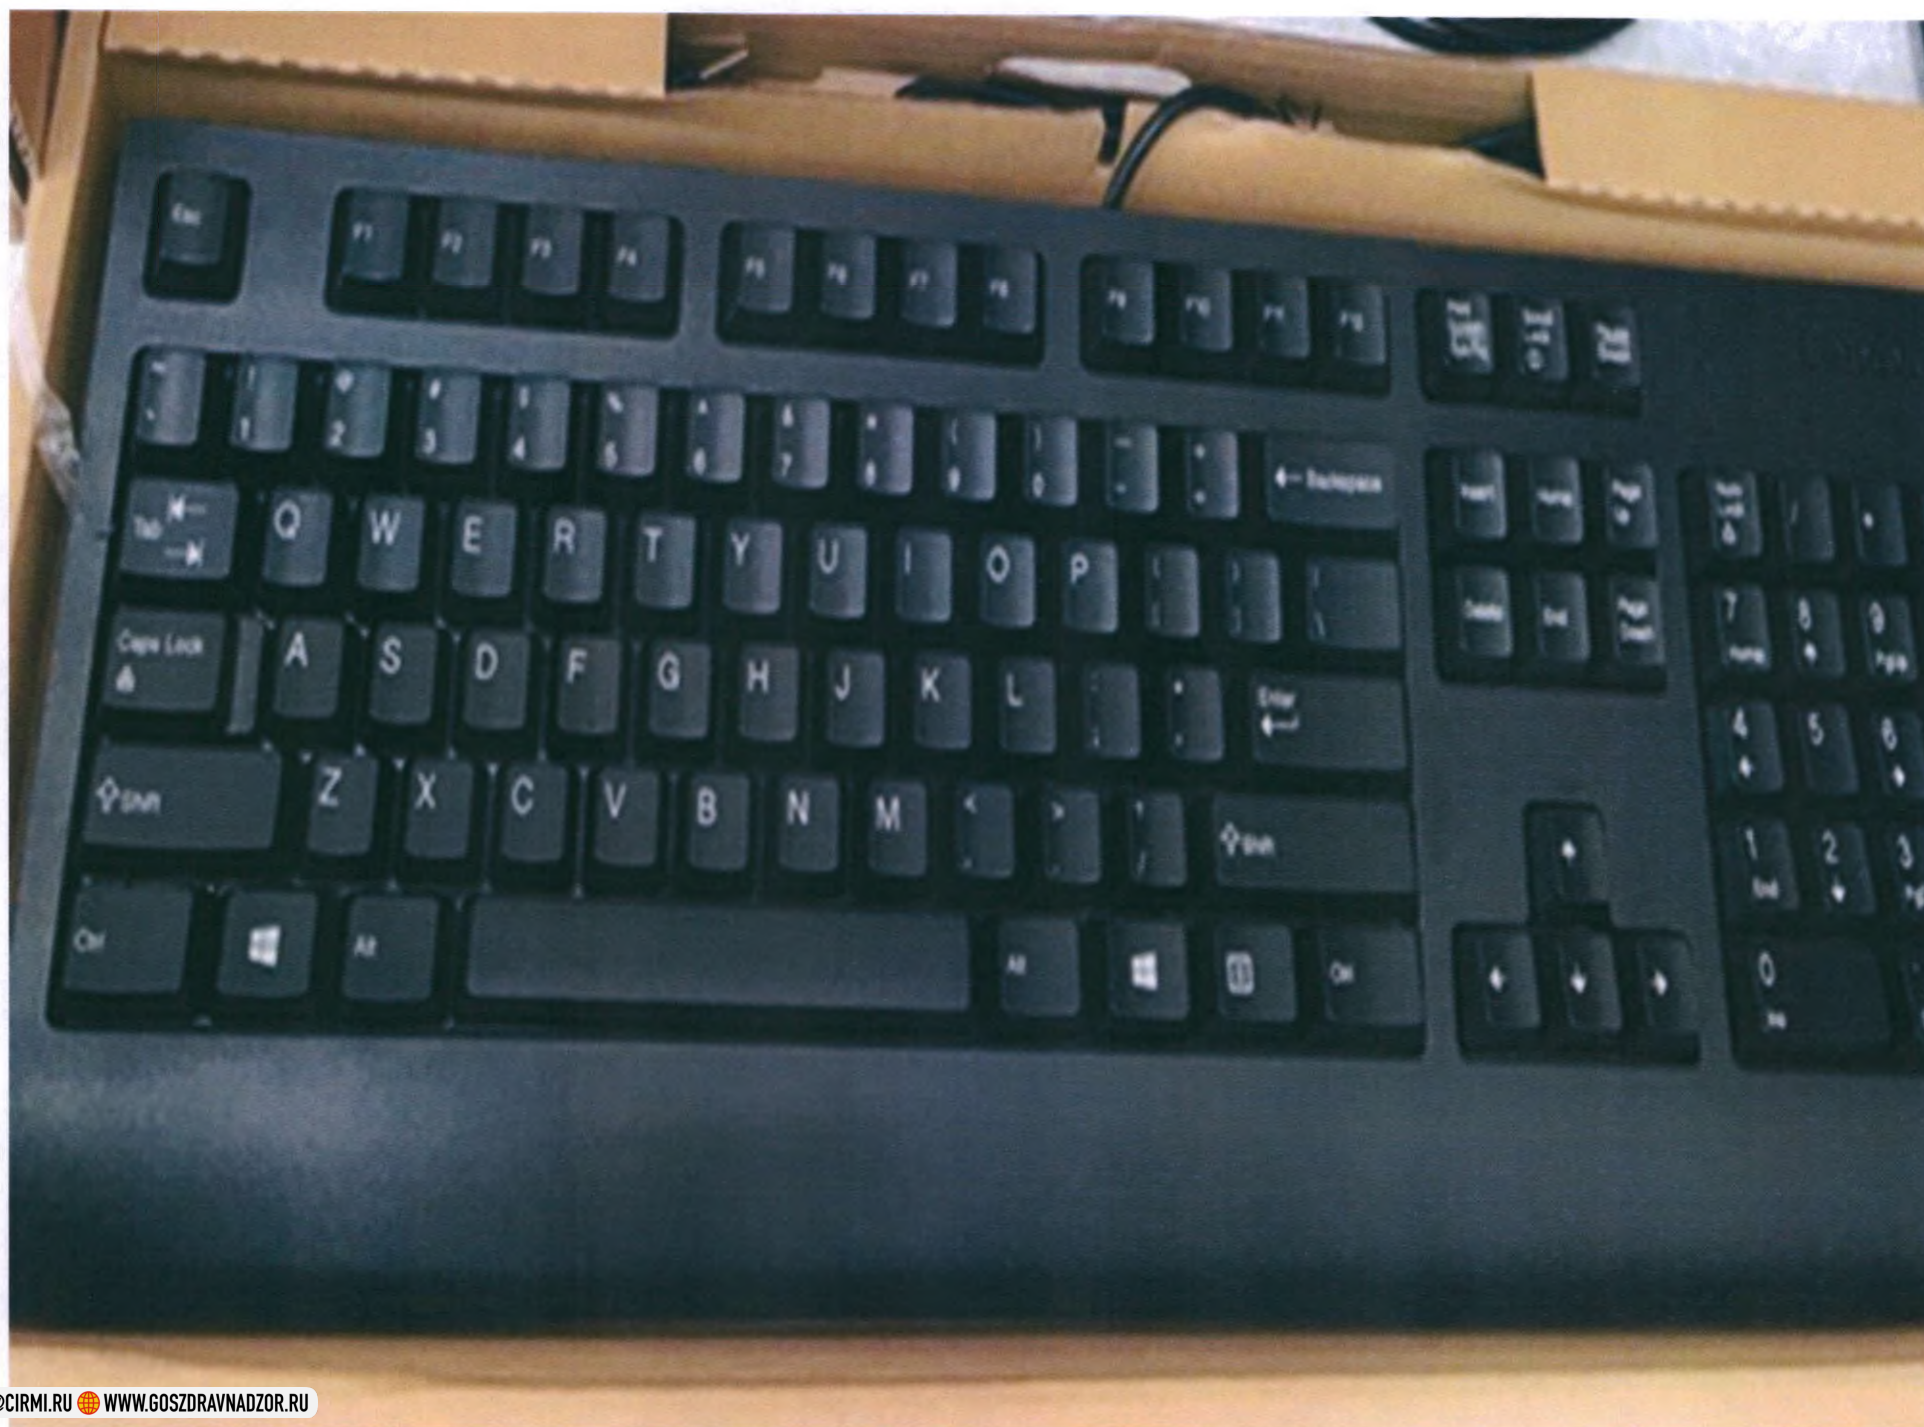

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - манипулятор «мышь» - 1 шт.

320

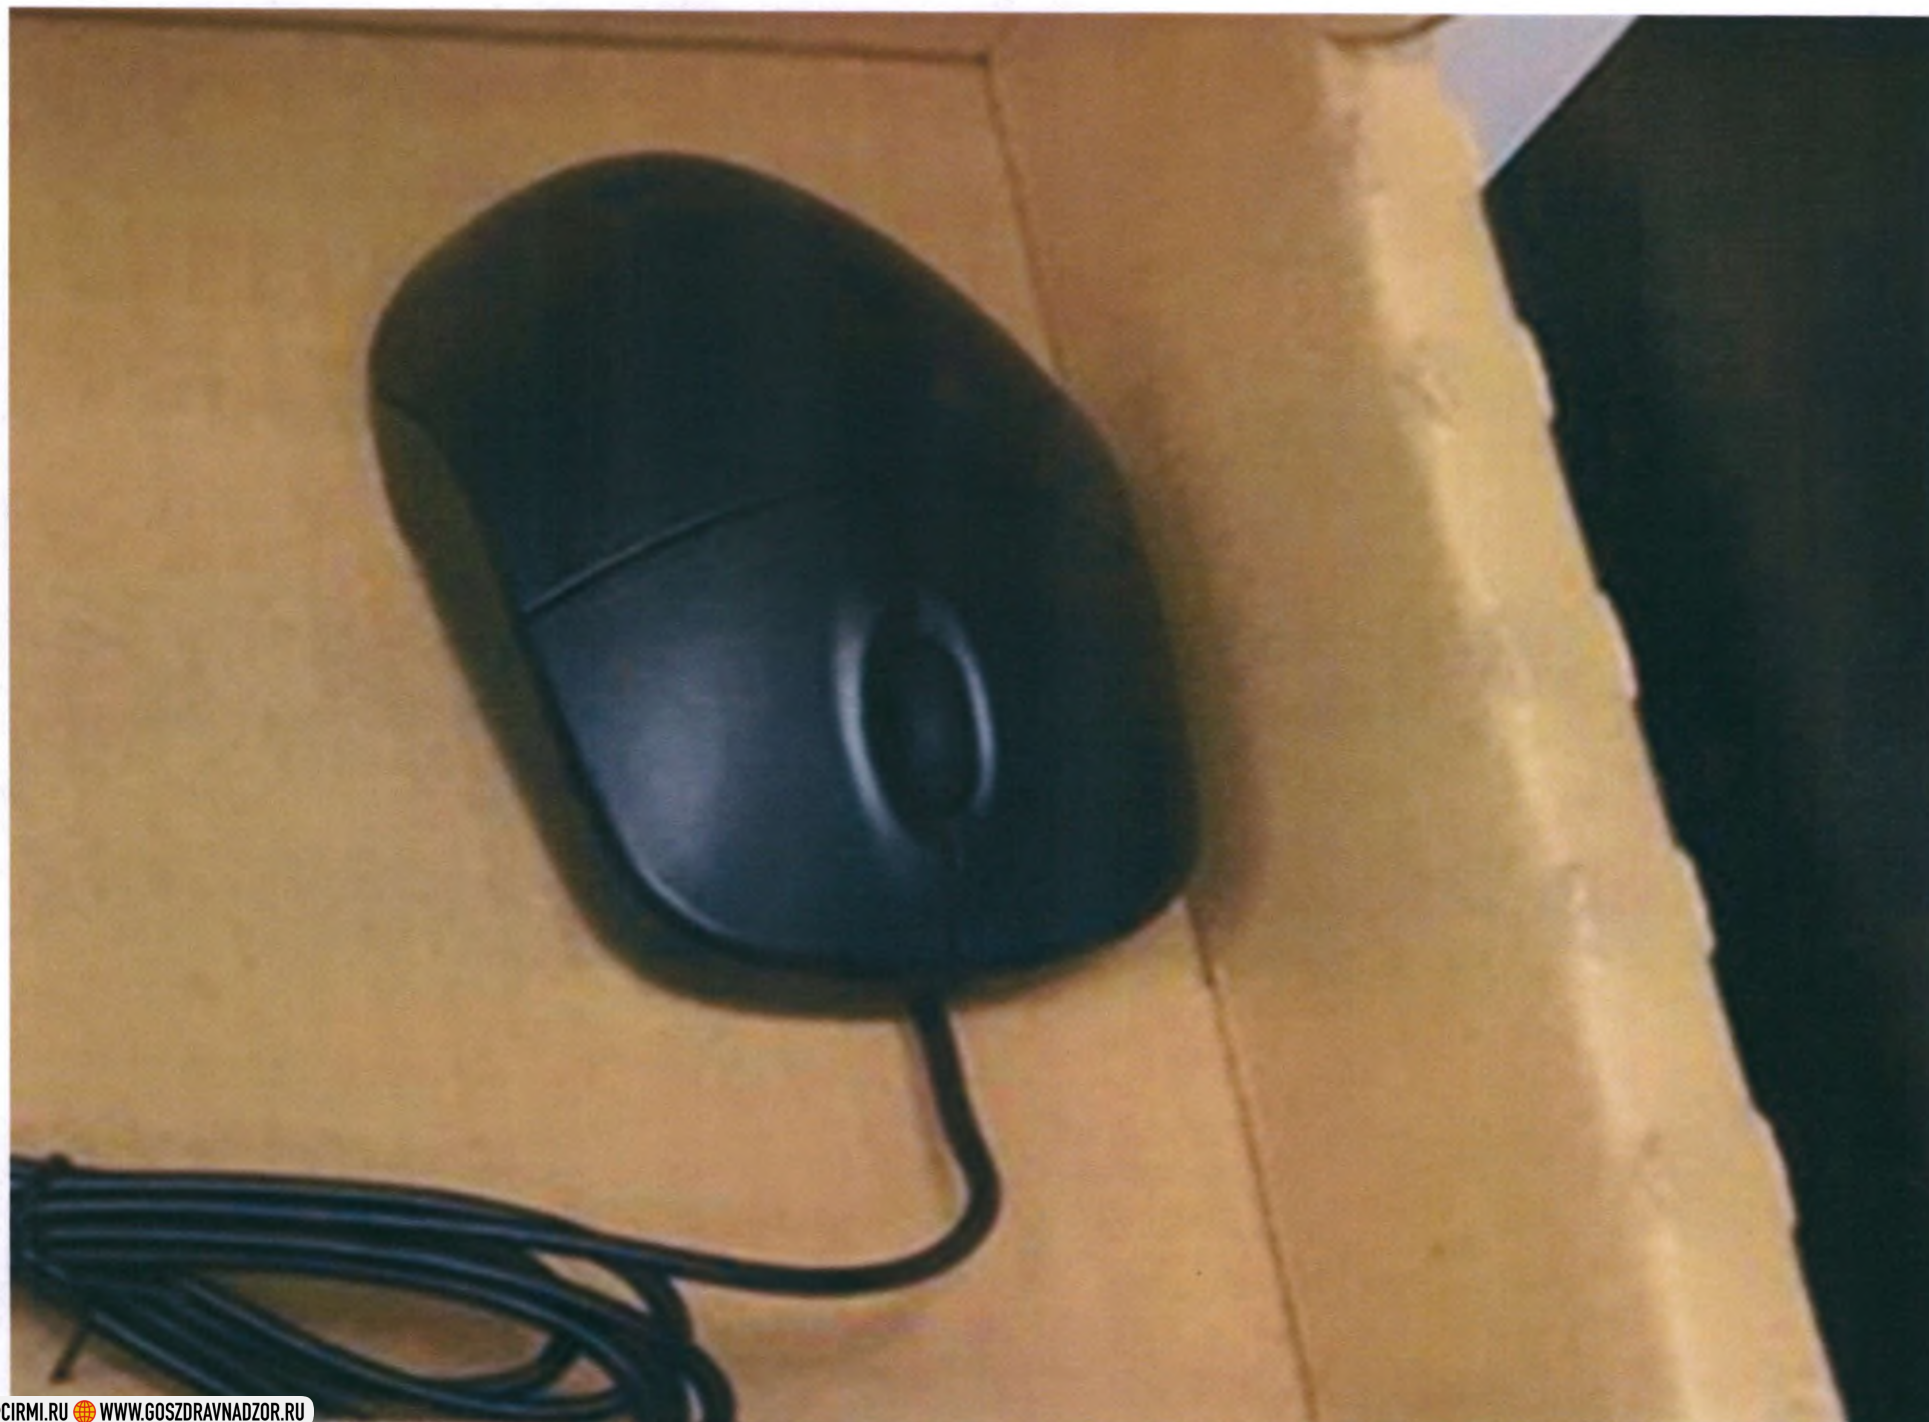


86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - концентратор - 1 шт.



86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - комплект кабелей - 4 шт.



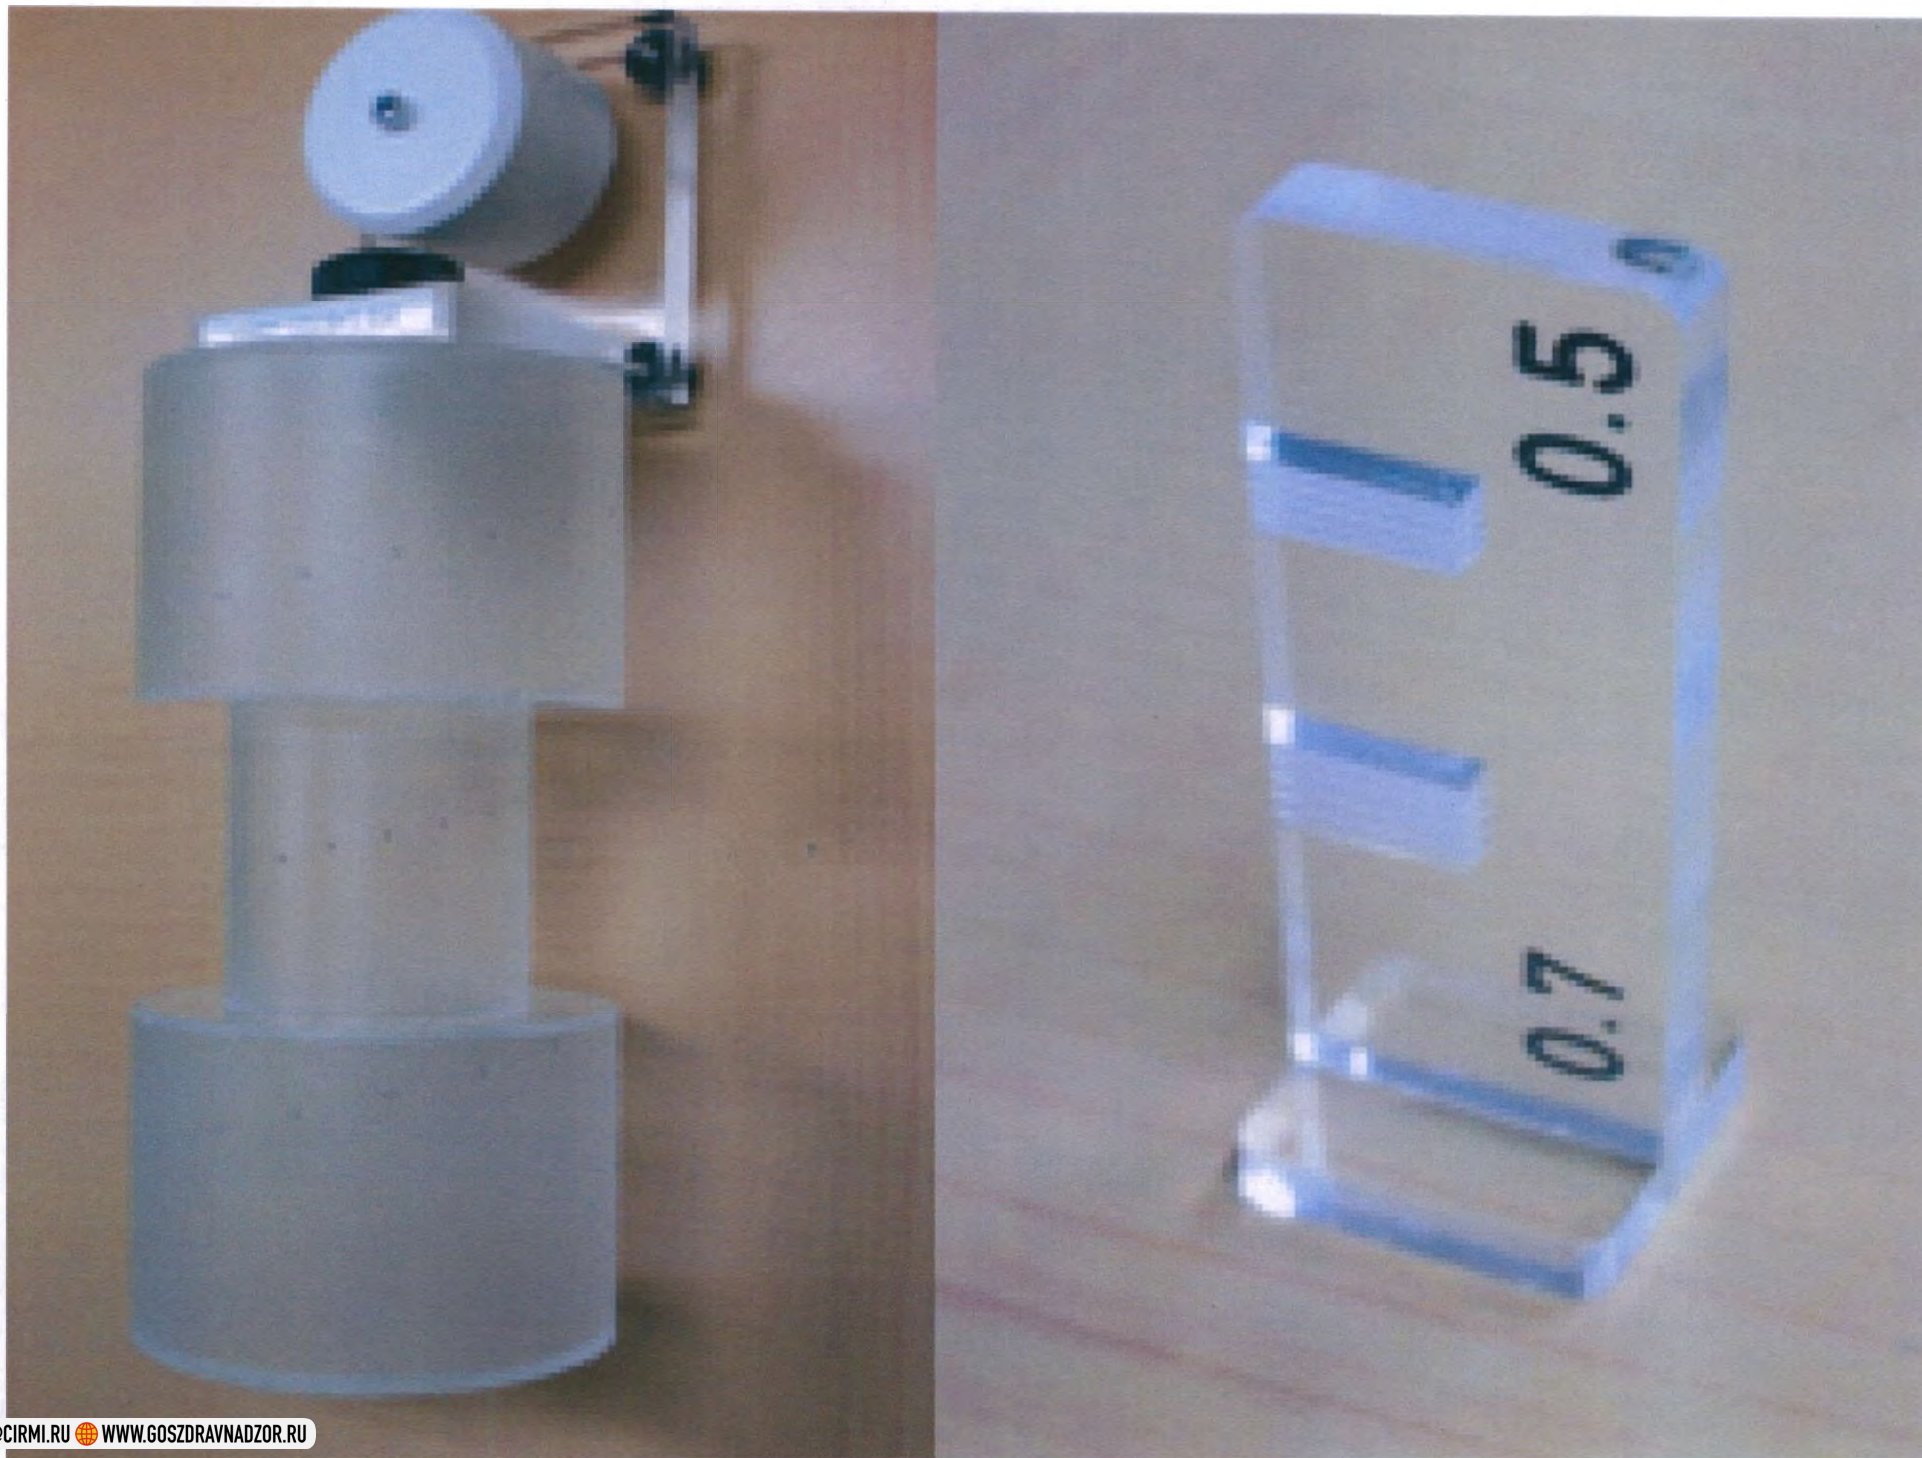


87. Монитор для Ангиографической рабочей станции - не более 4 шт.



88. Комплект дополнительного монитора для Ангиографической рабочей станции.



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет интерфейса для клинического анализа;

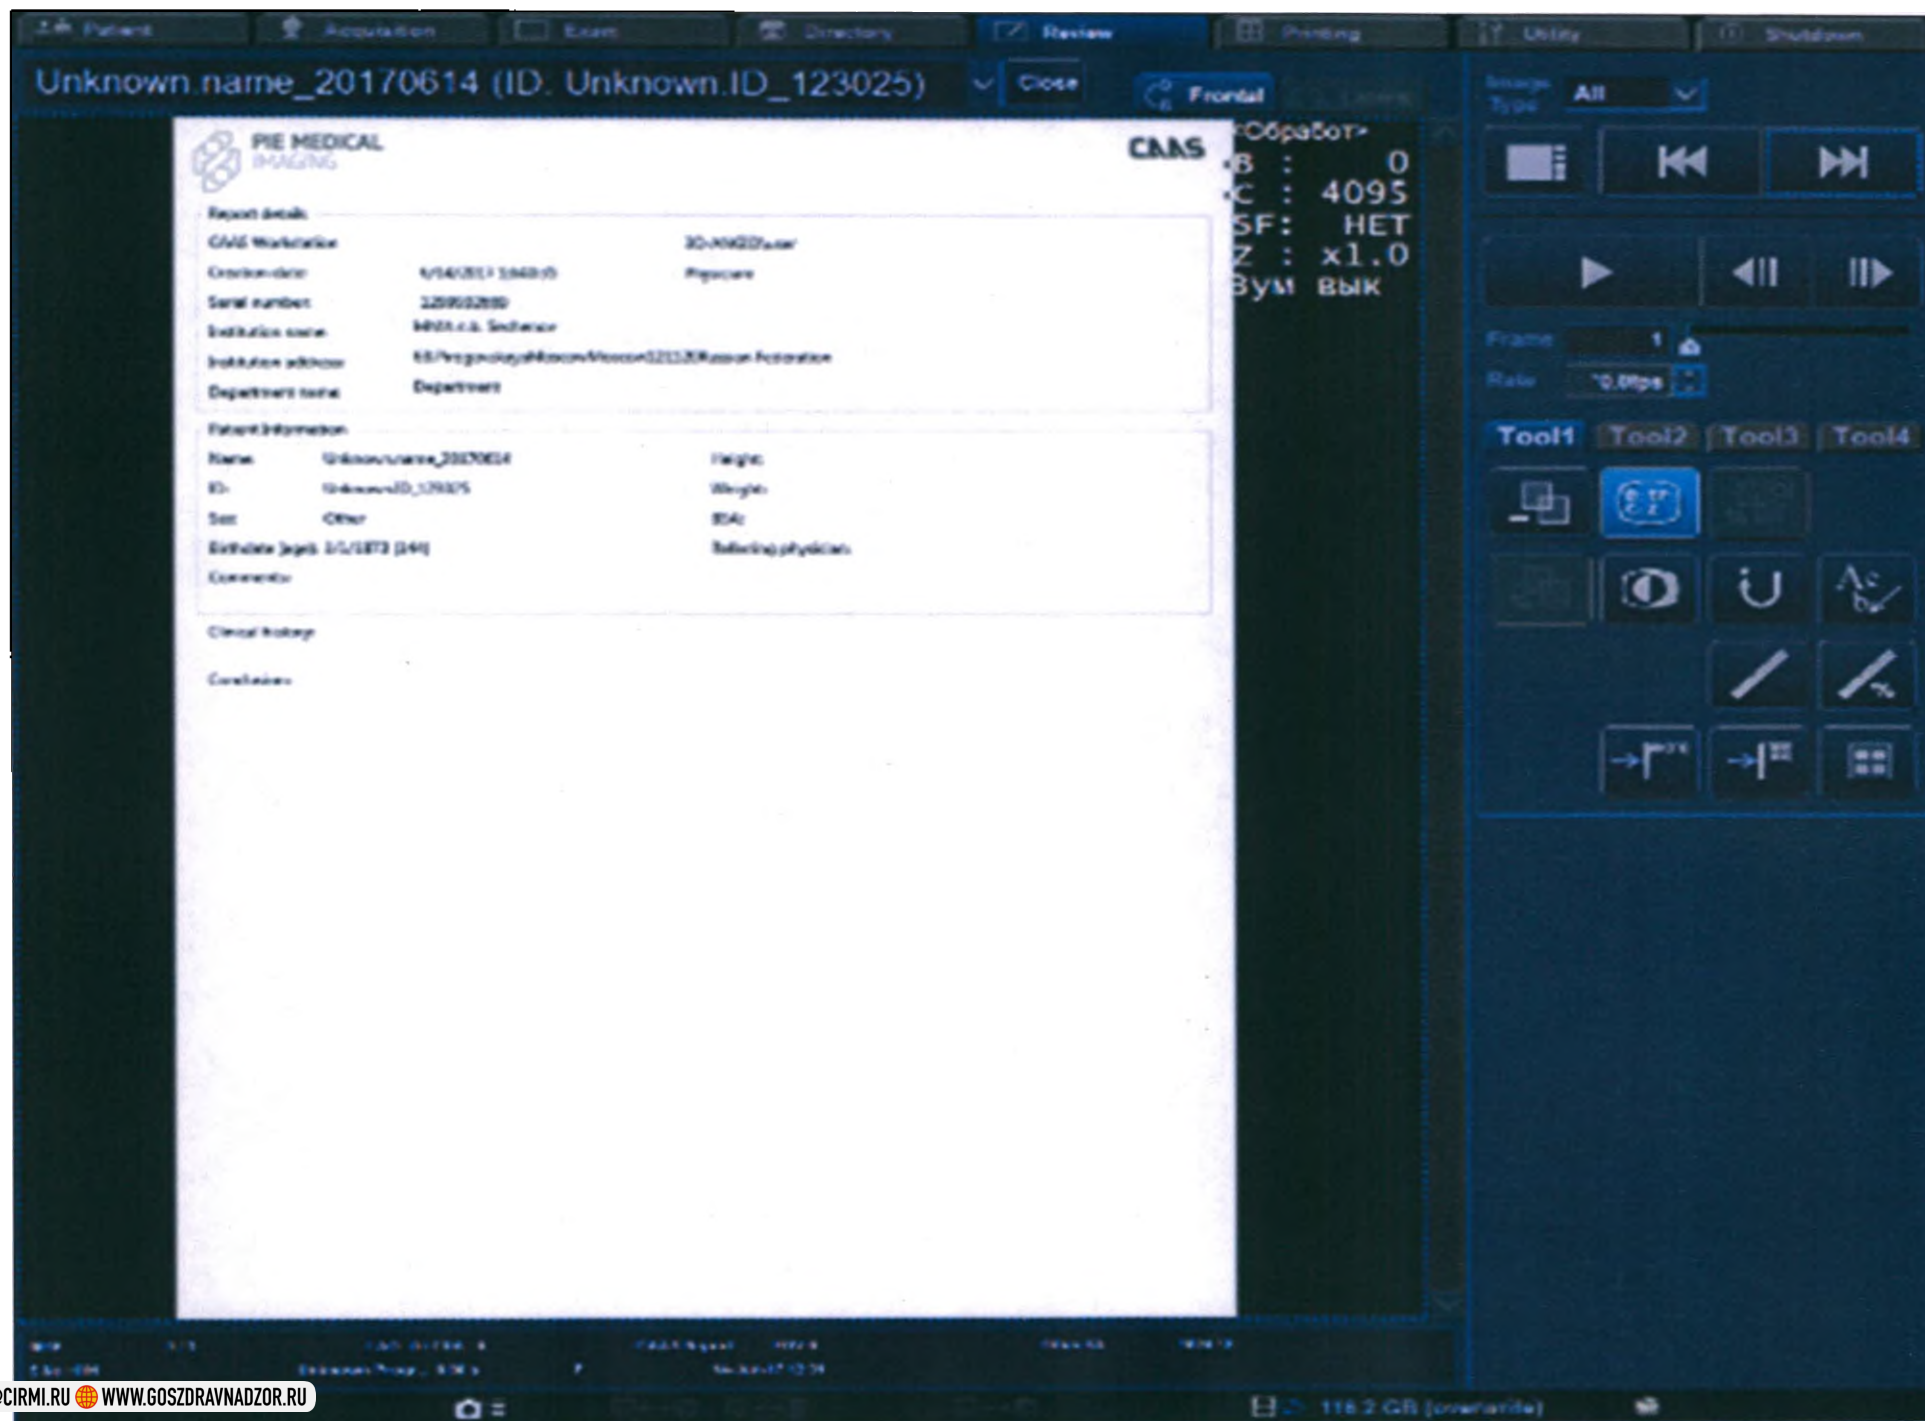

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QCA (анализ коронарных артерий)

CAAS Workstation 7.1.1 - 3Dadmin

Hide image ribbon

View

Patient

Hide report overview

QCA

Stere

LVA

RVA

Report

Save Report

DRONKOVA RAISA MIHAILOVNA - 15.06.2017

DRONKOVA RAISA MIHAILOVNA
20.03.1948
Female
XAJ0170615114022

PIE MEDICAL IMAGING

CAAS

Report details

CAAS Workstation	3D-ANGIO3Dadmin	
Creation date:	15.06.2017 17:11:40	Physician:
Serial number	1299932669	
Institution name:	MSA n.b. Sechenov	
Institution address:	68.PirogovskayaMoscowMoscow121120Russian Federation	
Department name:	Department	

Patient Information

Name:	DRONKOVA RAISA MIHAILOVNA	Height:	167 cm
ID:	37 478/2017	Weight:	120 kg
Sex:	Female	BSA:	2.15 m ²
Birthdate (age):	20.03.1948 (69)	Referring physician:	

Comments:

Clinical history:

Conclusion:

CAAS Workstation 7.1.1

1 / 2

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QVA (анализ сосудов)



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа LVA (анализ левого желудочка)

CAAS Workstation 7.1.1 - 3Dadmin

Hide image ribbon

DRICENKOVA RAISA MD-48.0VNUA - 15.06.2017

CAAS

DRICENKOVA RAISA MD-48.0VNUA
20.01.1948
Female
KA20170615114022

Report
☒ Header Page
 Viewing
☒ QCA 1

View
 Patient
 QCA
 Share
 LVA
 RVA
 Report
 Save Report

Hide report overview

PIE MEDICAL IMAGING

CAAS

Report details

CAAS Workstation	3D-ANGIO3Dadmin	
Creation date:	15.06.2017 17:11:40	Physician:
Serial number:	1299932669	
Institution name:	MMA n.b. Sechenov	
Institution address:	68.PirogovskayaMoscowMoscow121120Russian Federation	
Department name:	Department	

Patient Information

Name:	DRICENKOVA RAISA MD-48.0VNUA	Height:	167 cm
ID:	37 478/2017	Weight:	110 kg
Sex:	Female	BSA:	2.16 m ²
Birthdate (age):	20.01.1948 (69)	Referring physician:	

Comments

Clinical history


Conclusions

CAAS Workstation 7.1.1


1 / 2

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа RVA (анализ правого желудочка)

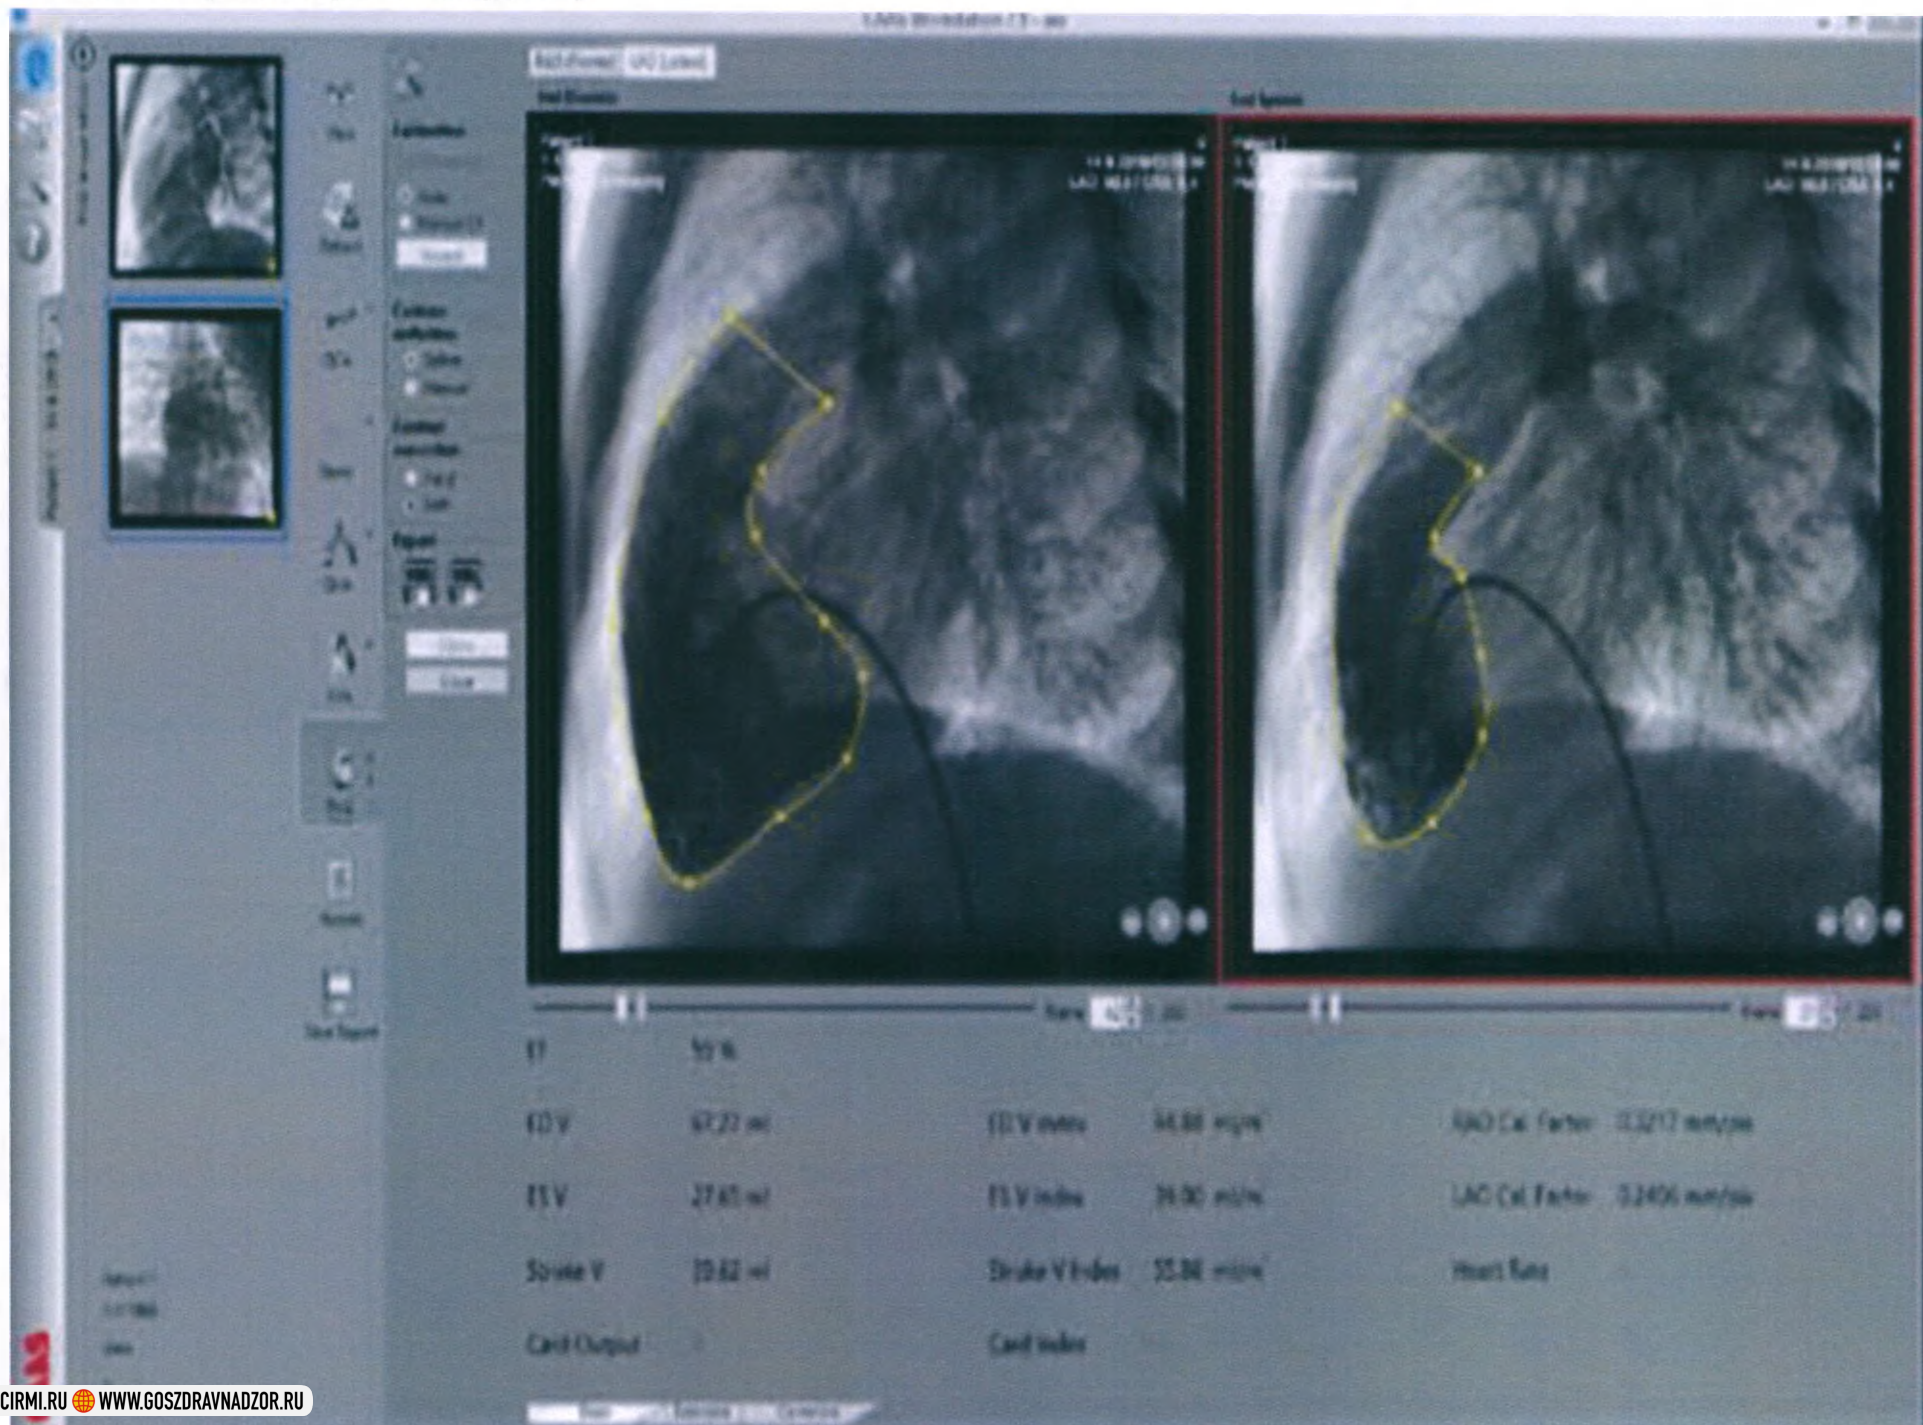


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QCA3D (3D-анализ коронарных артерий)

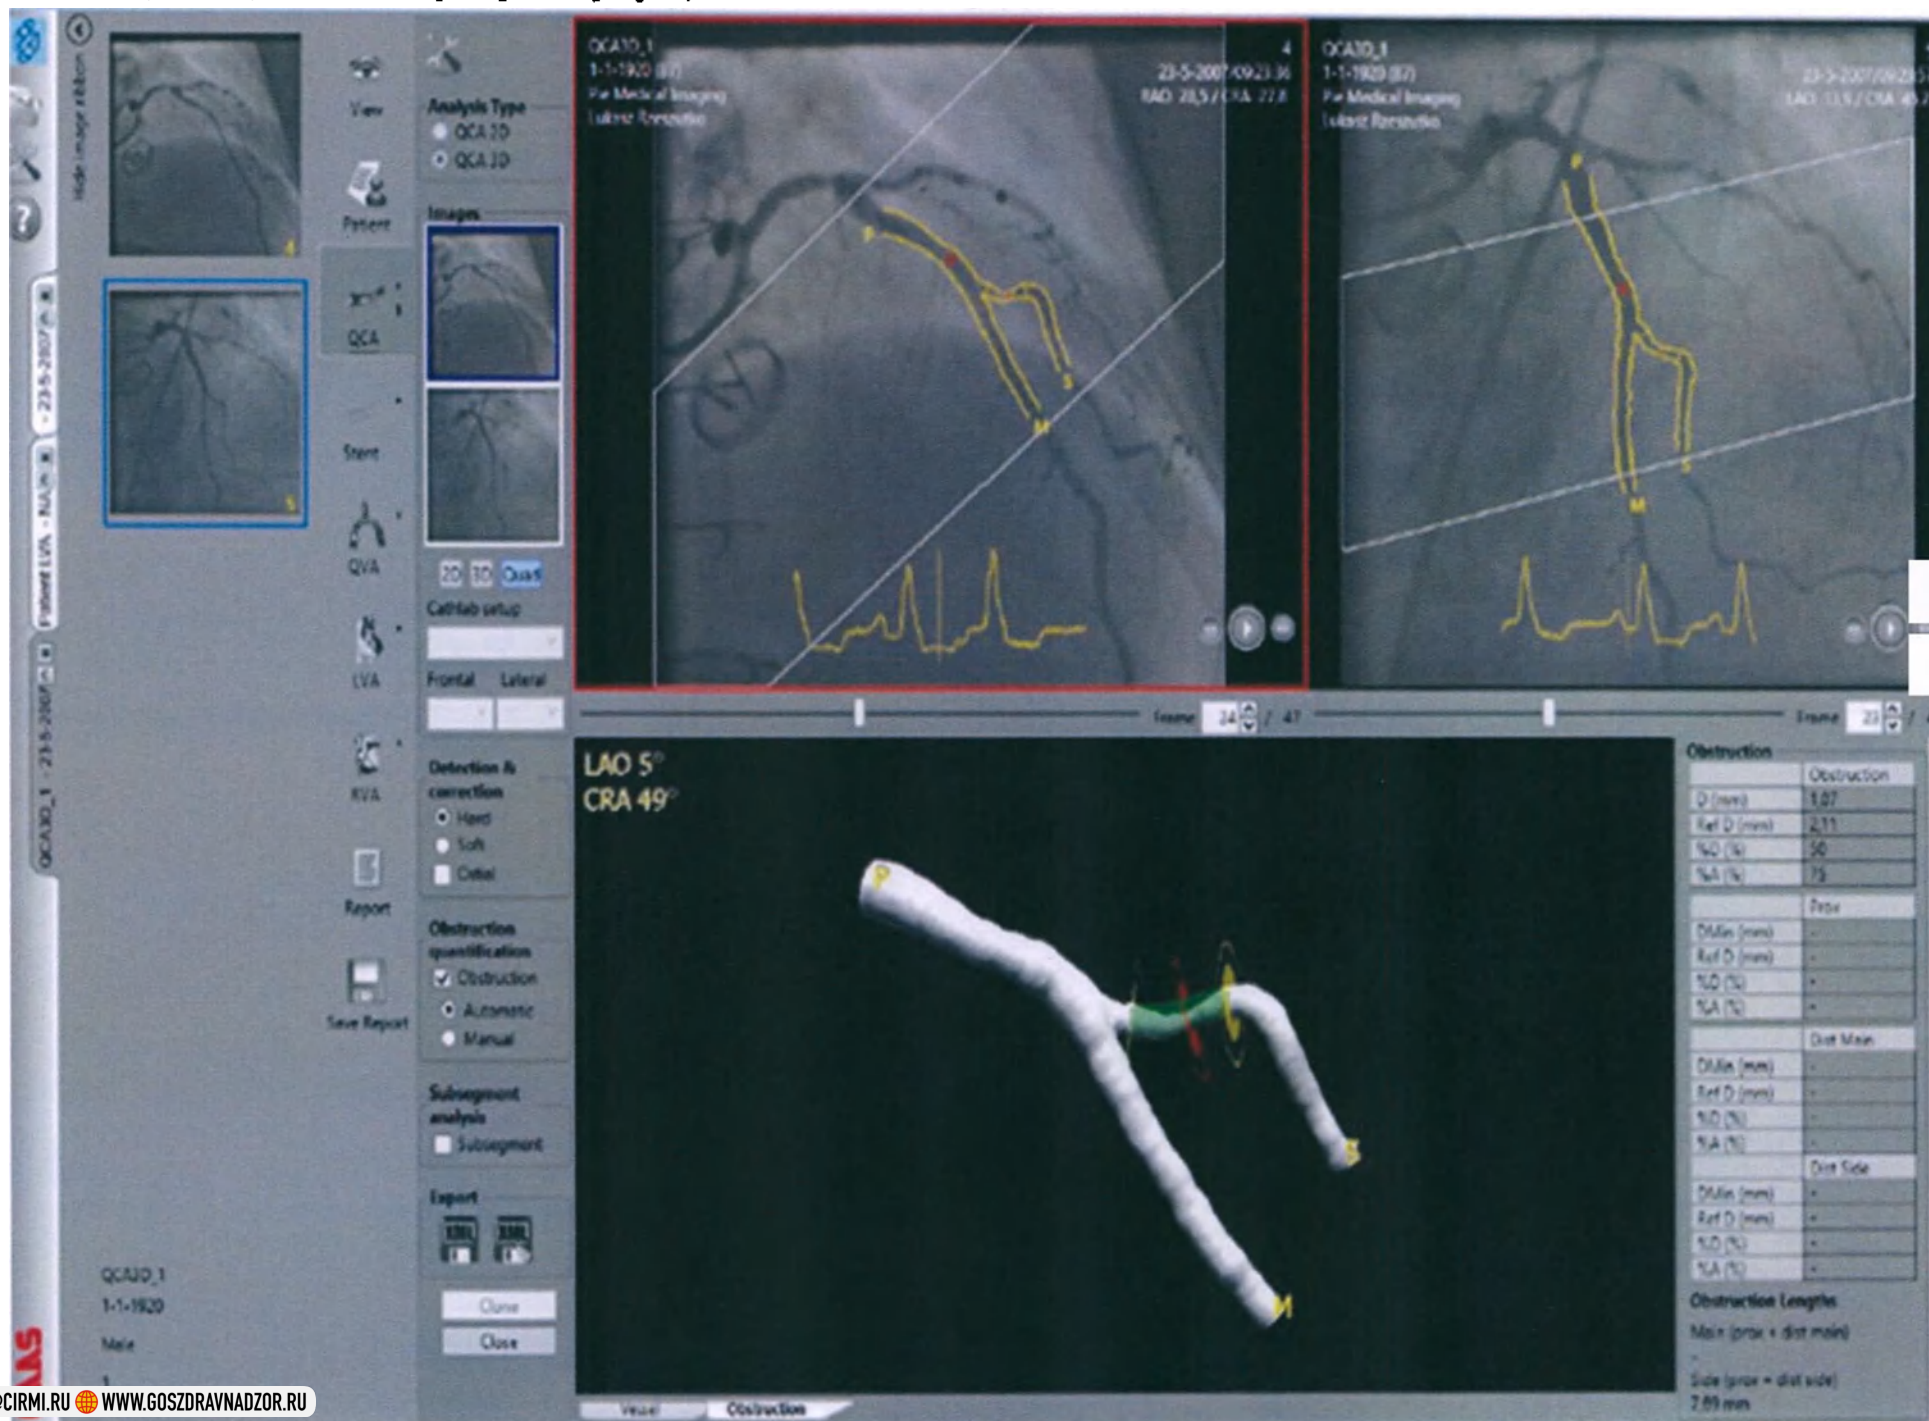


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа Stent Enhancer (отображение с контрастированием стента)

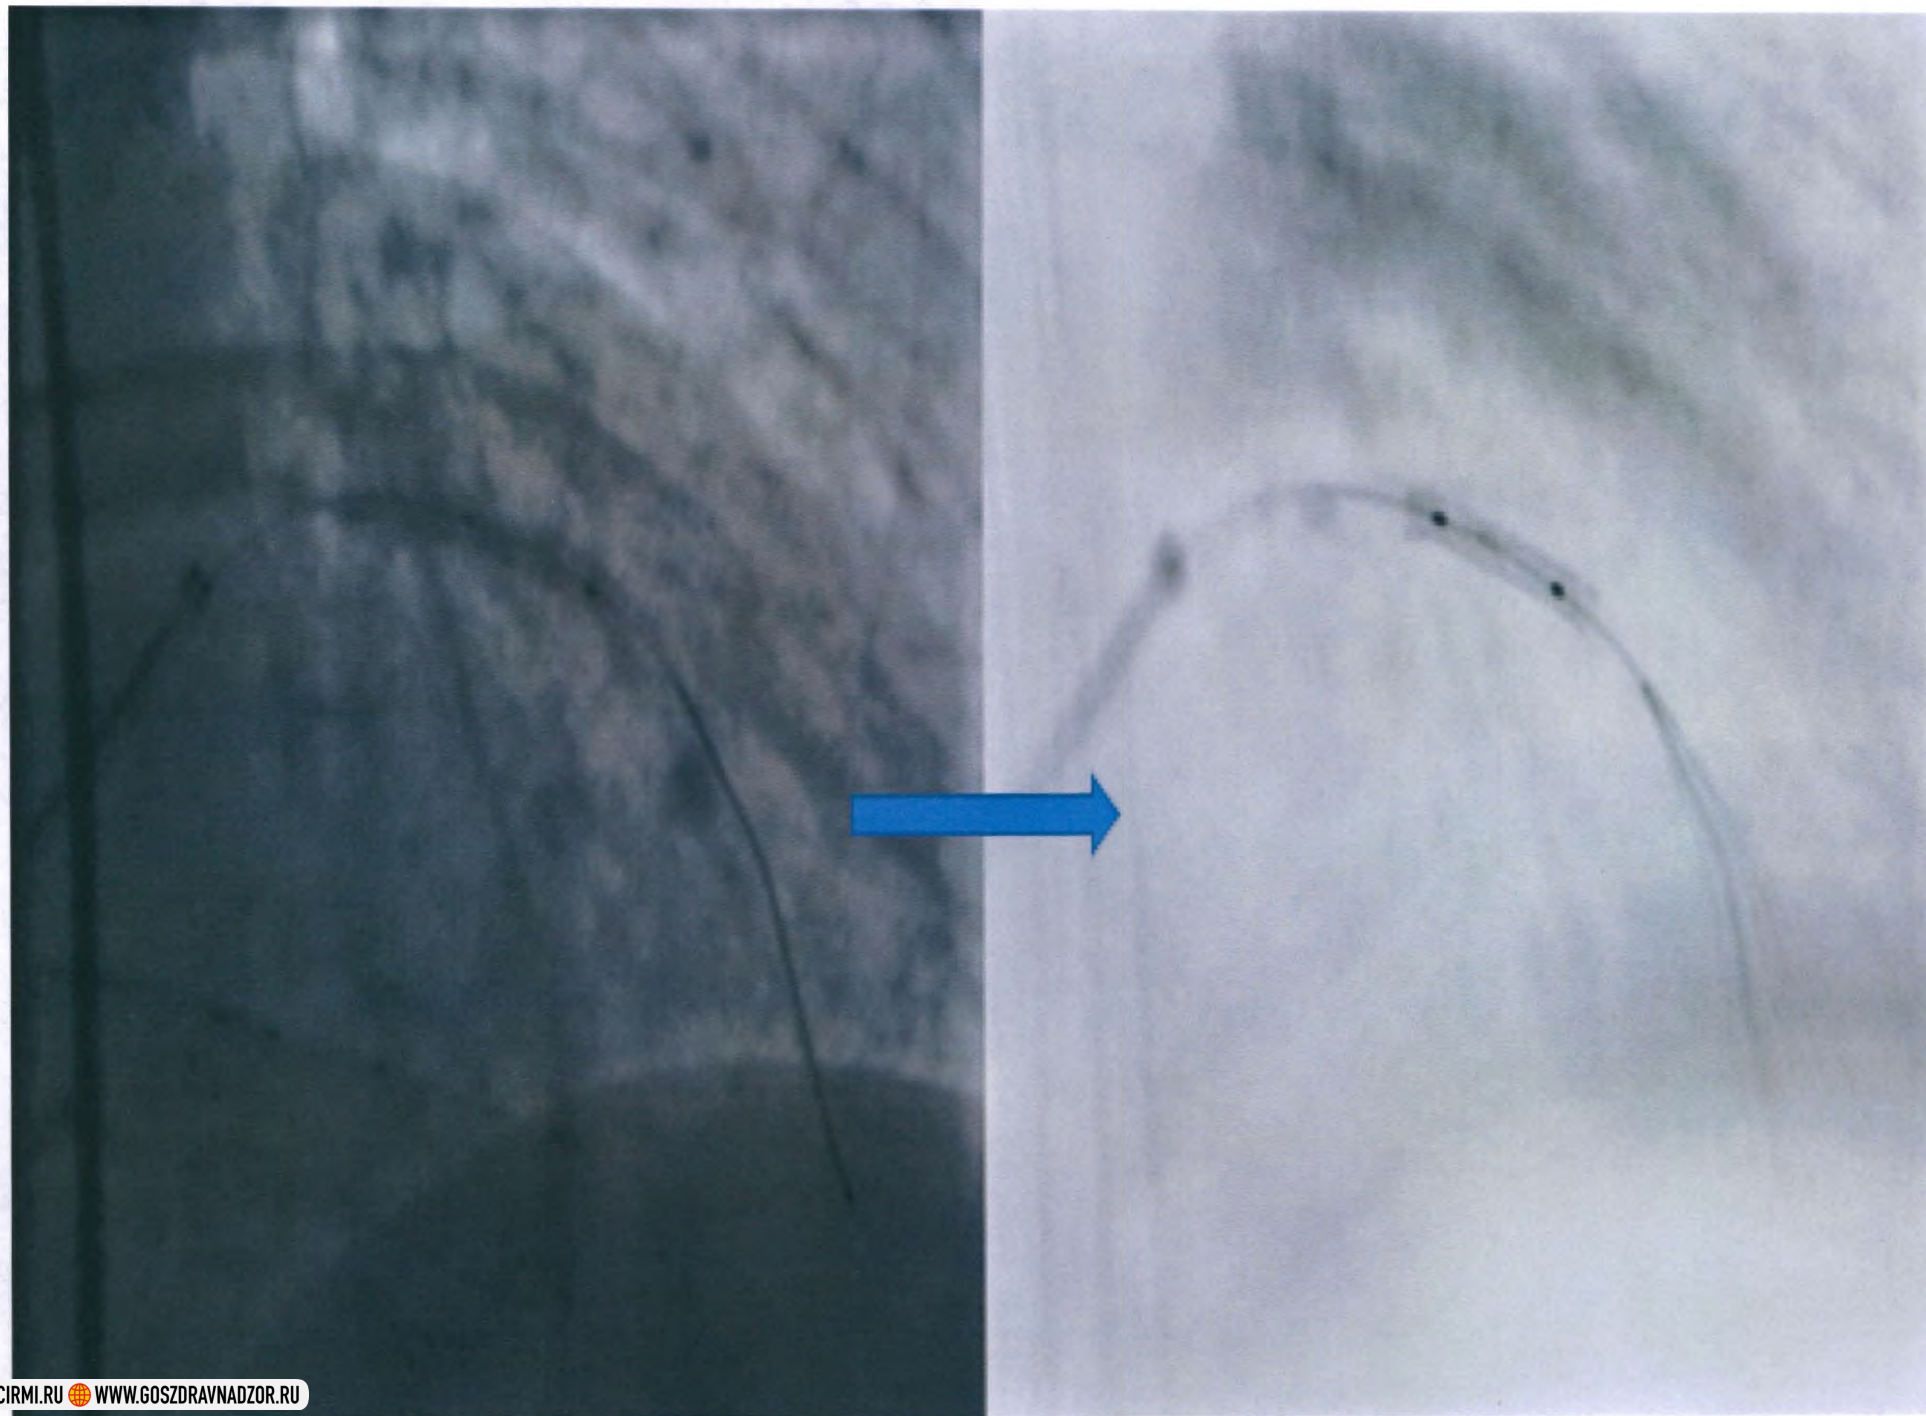

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа IV-LINQ (одновременная регистрация рентгеновских изображений и изображений ВСУЗИ/ОКТ)

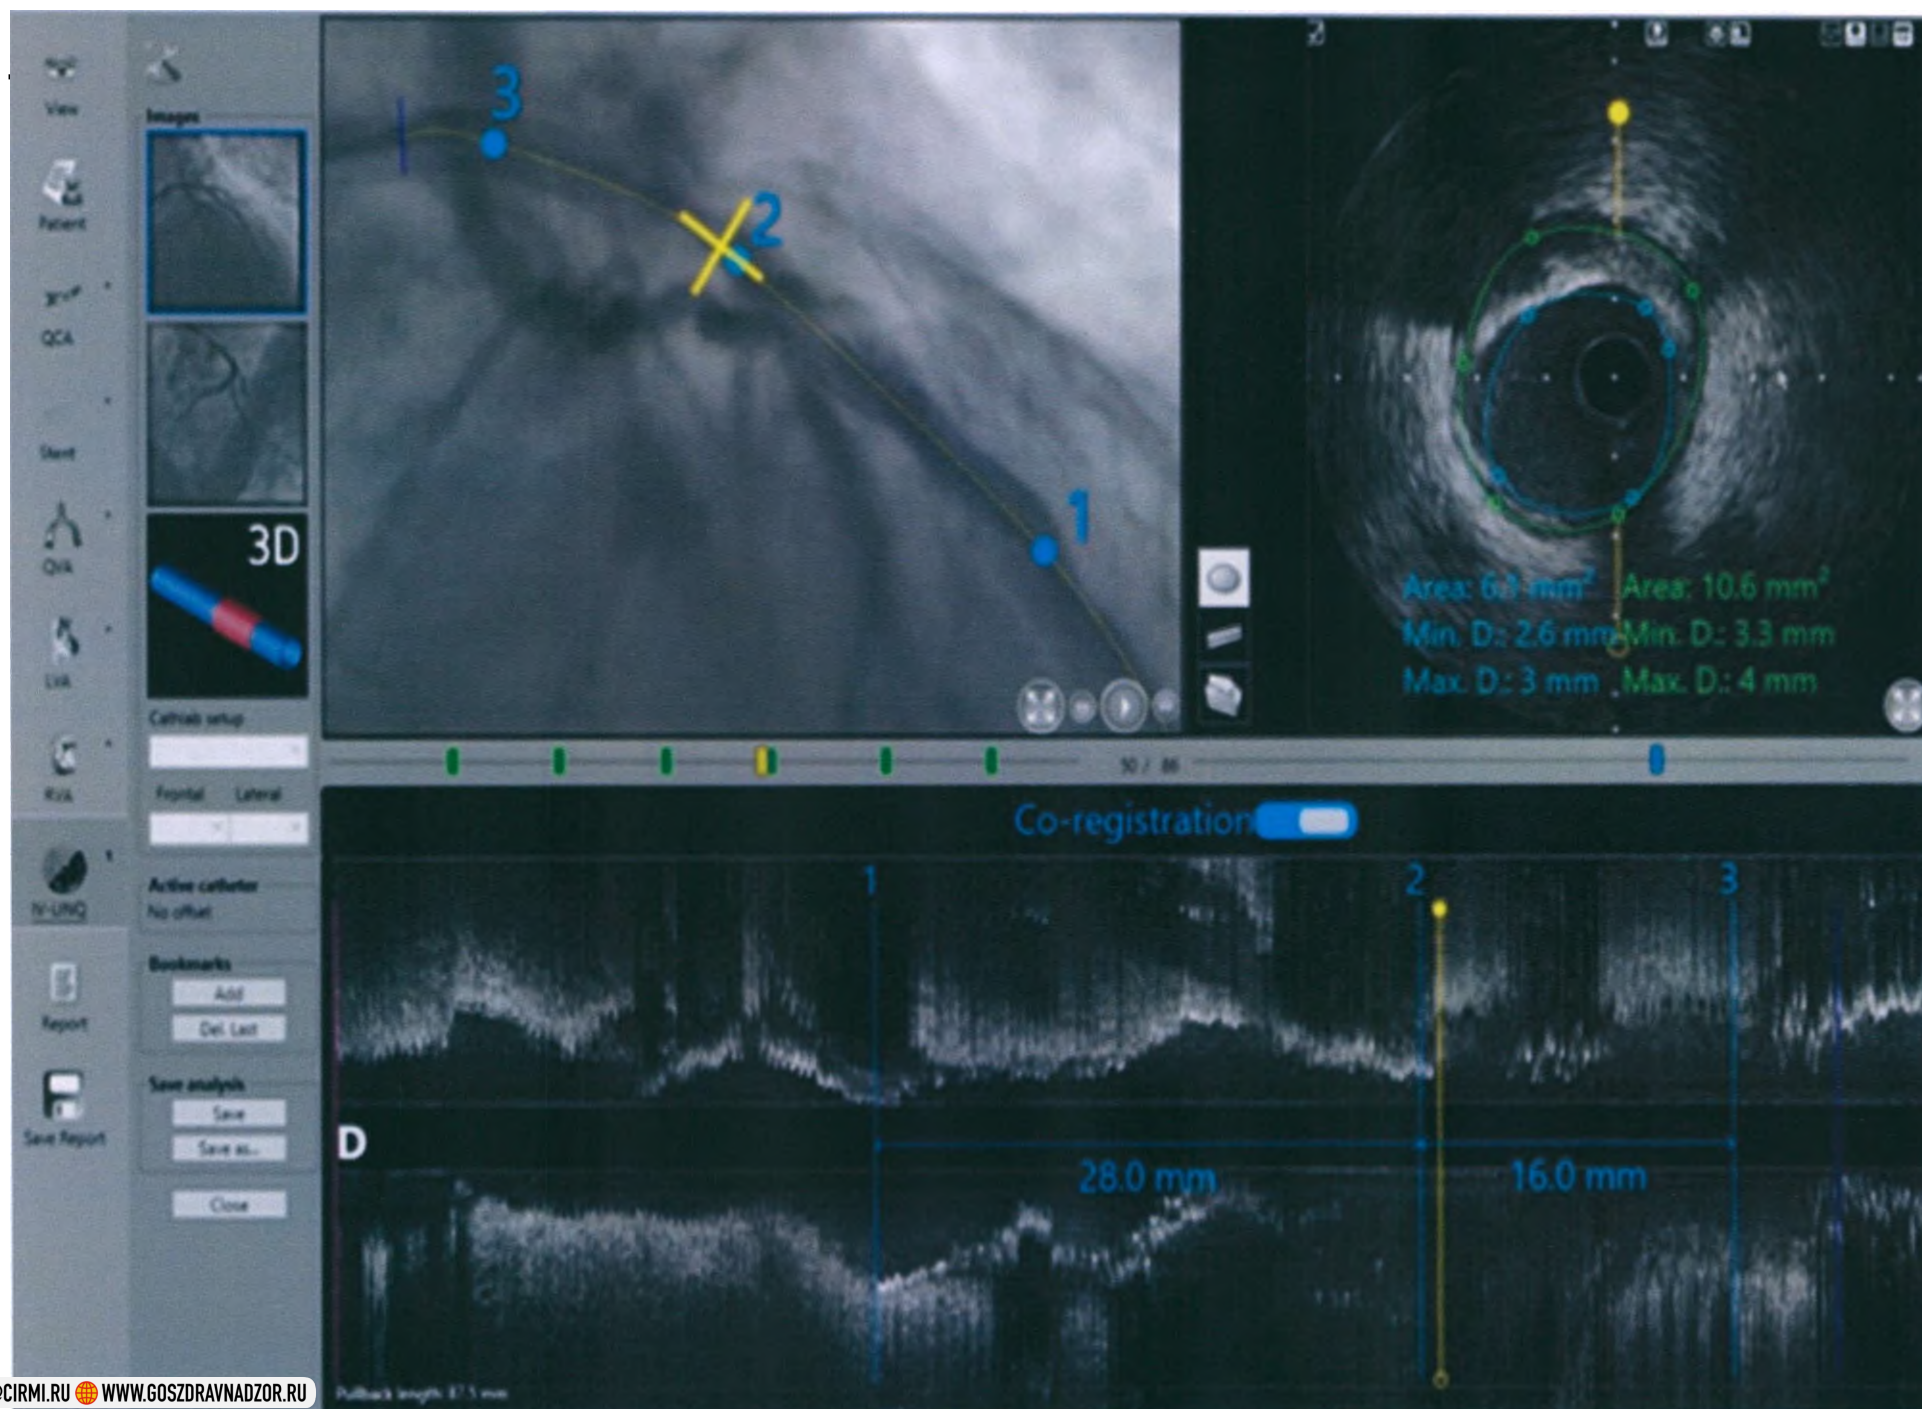


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для 3D-картирования;

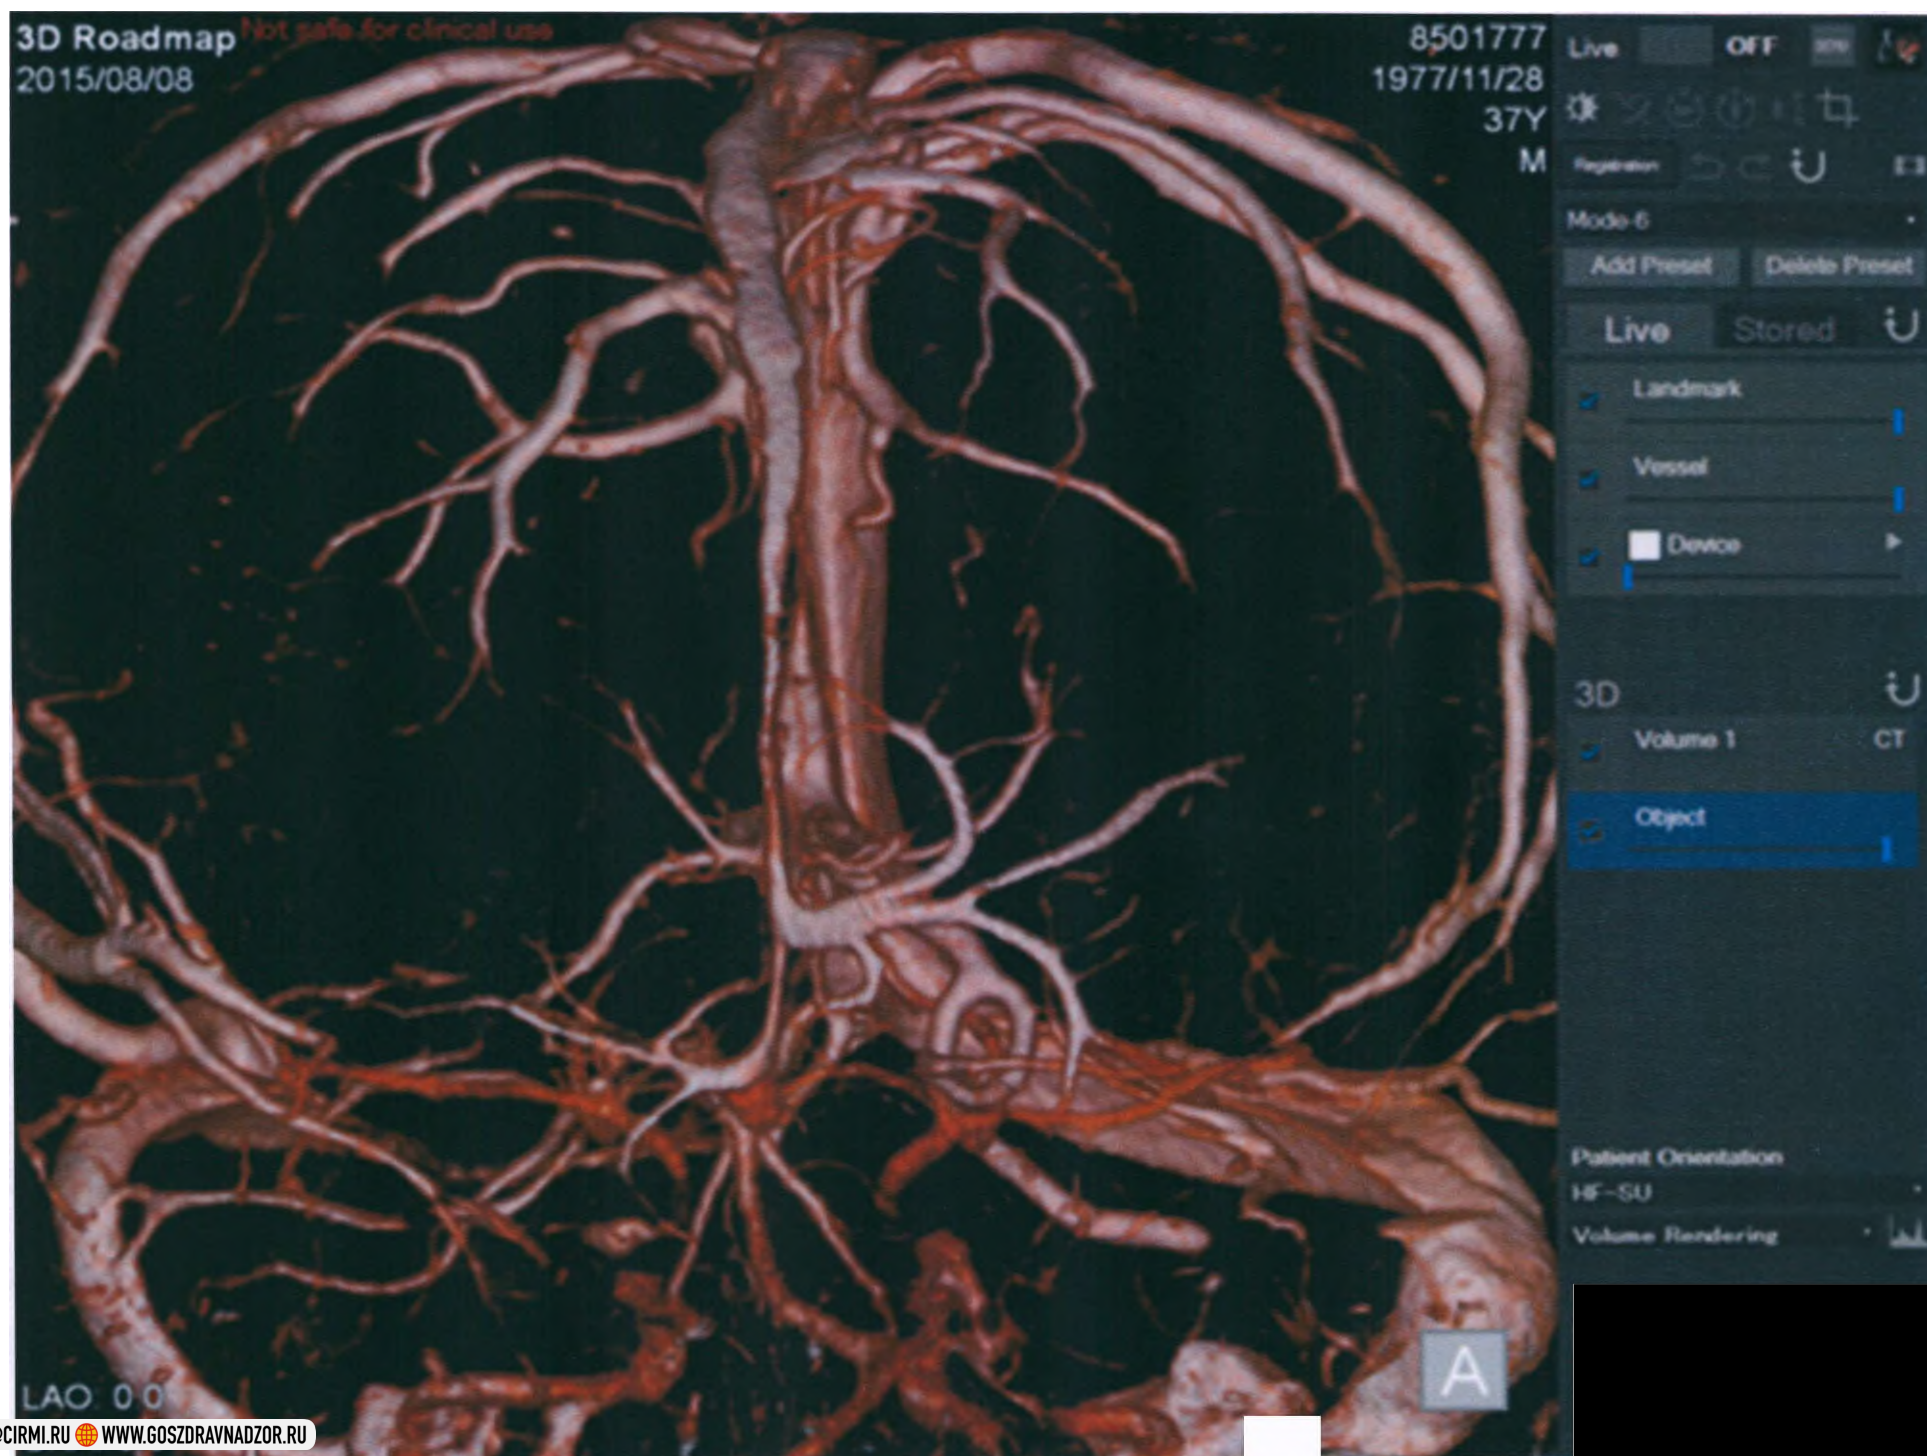


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для мультимодально-




89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для поддержки TAVR (3mensio);

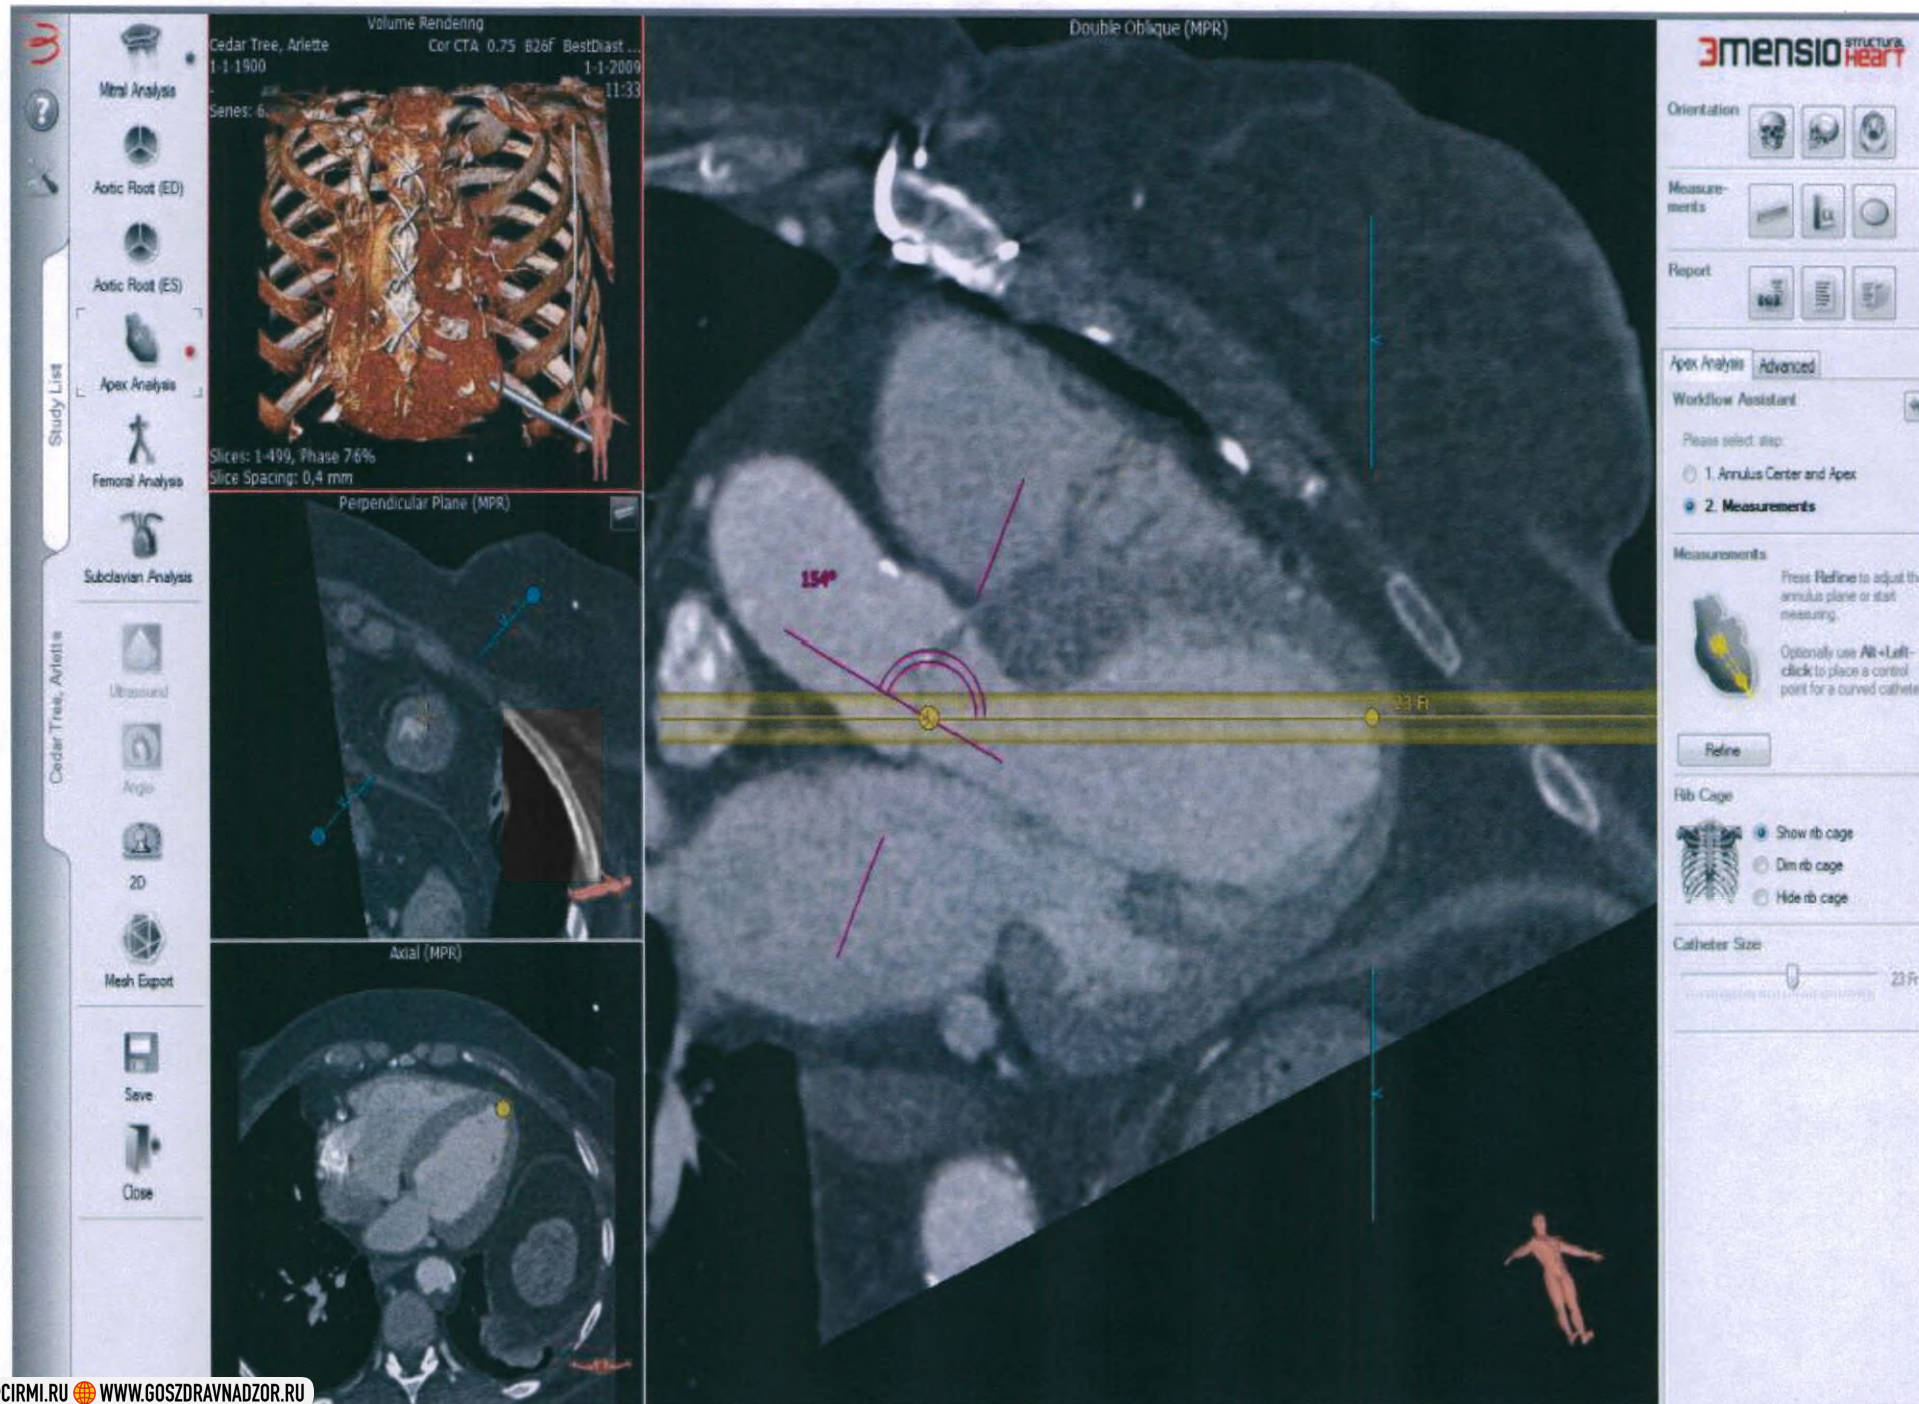


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для поддержки TAVR (3mensio и CAAS A-Valve);

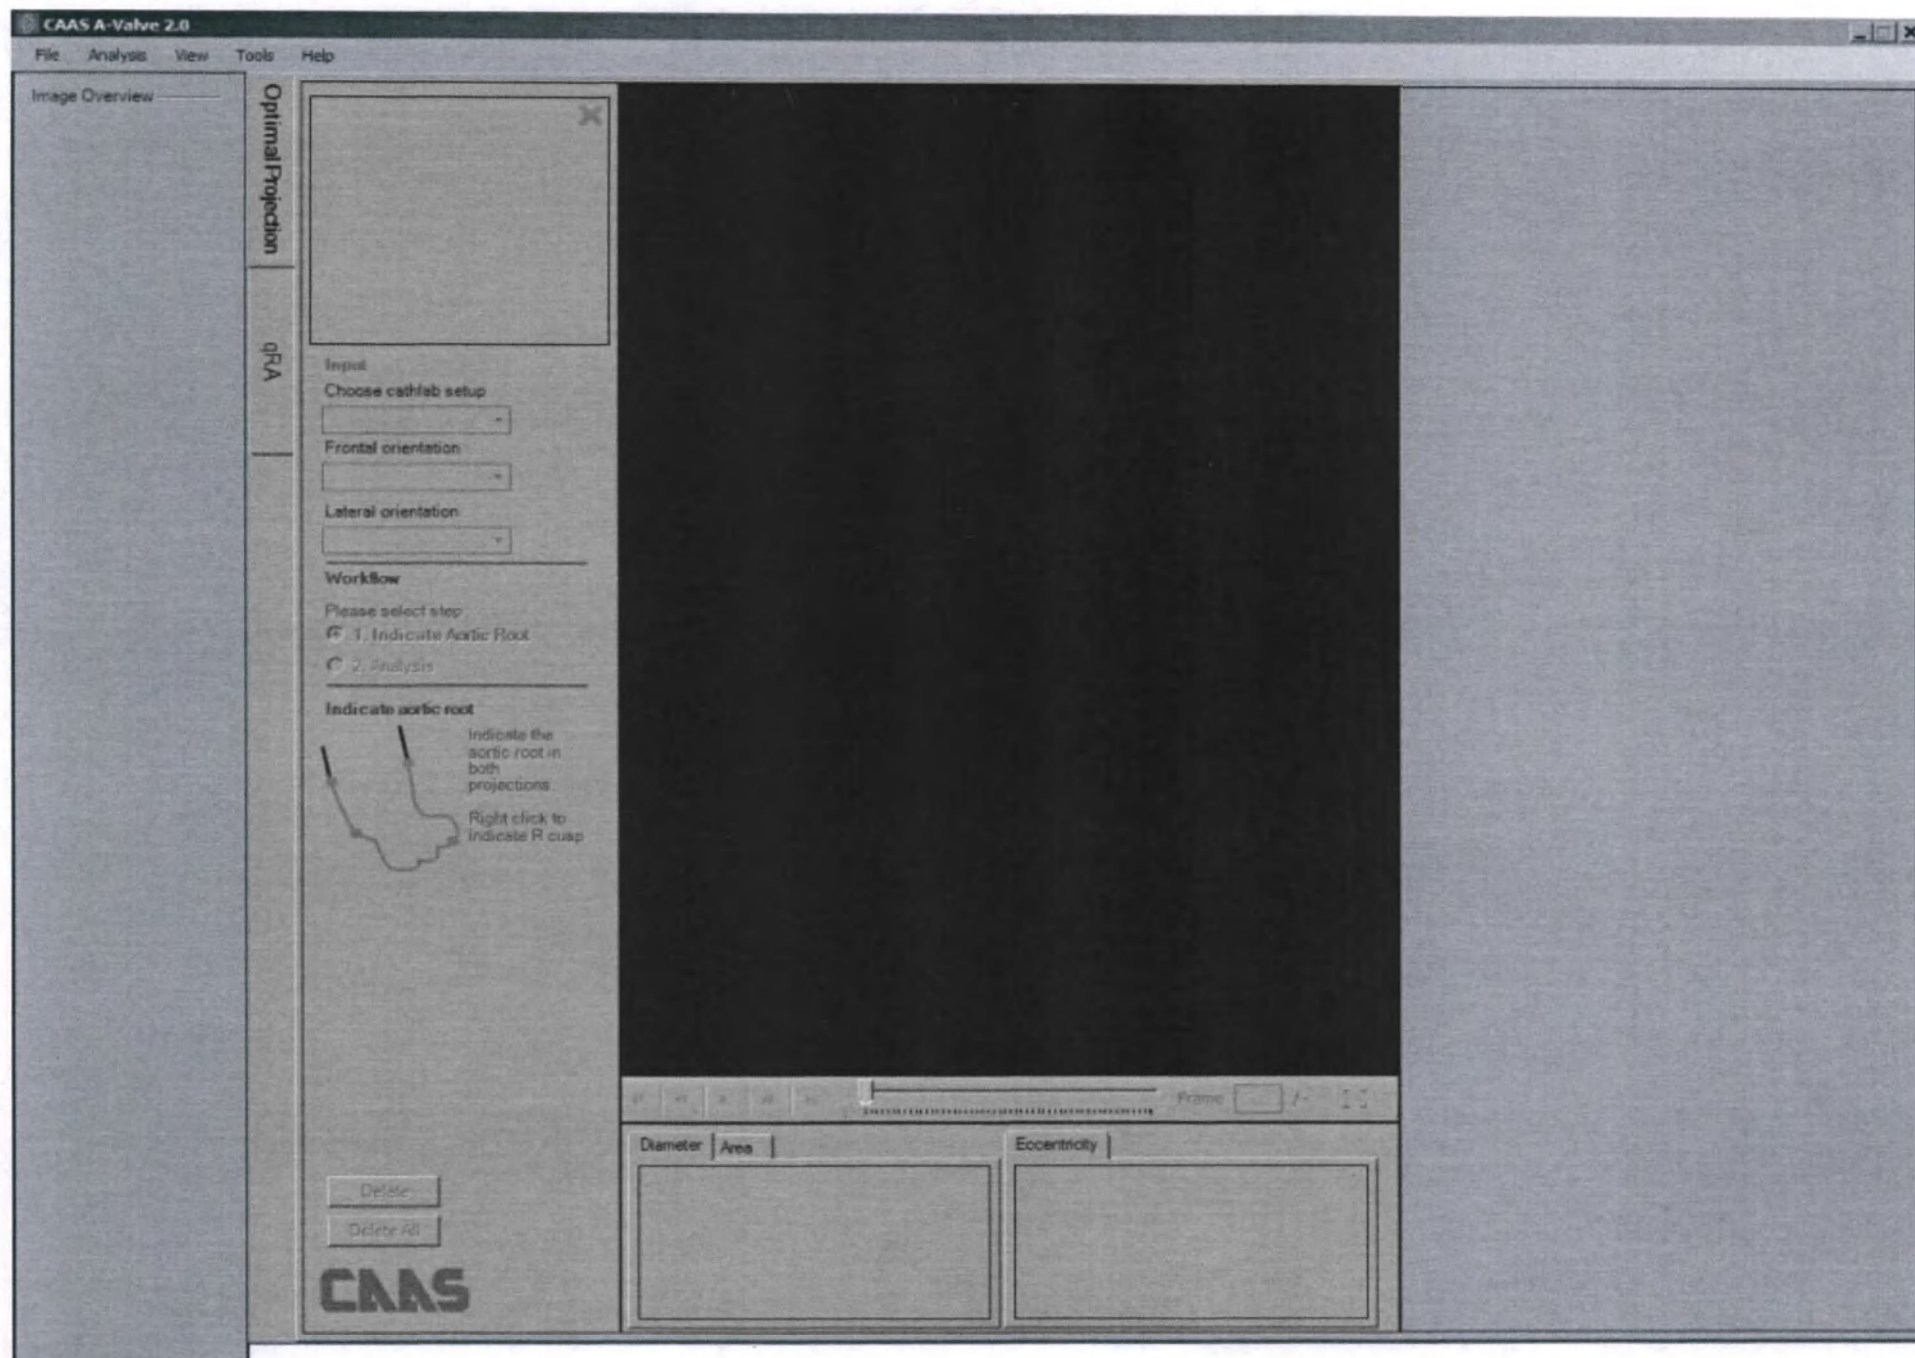


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа митрального клапана;

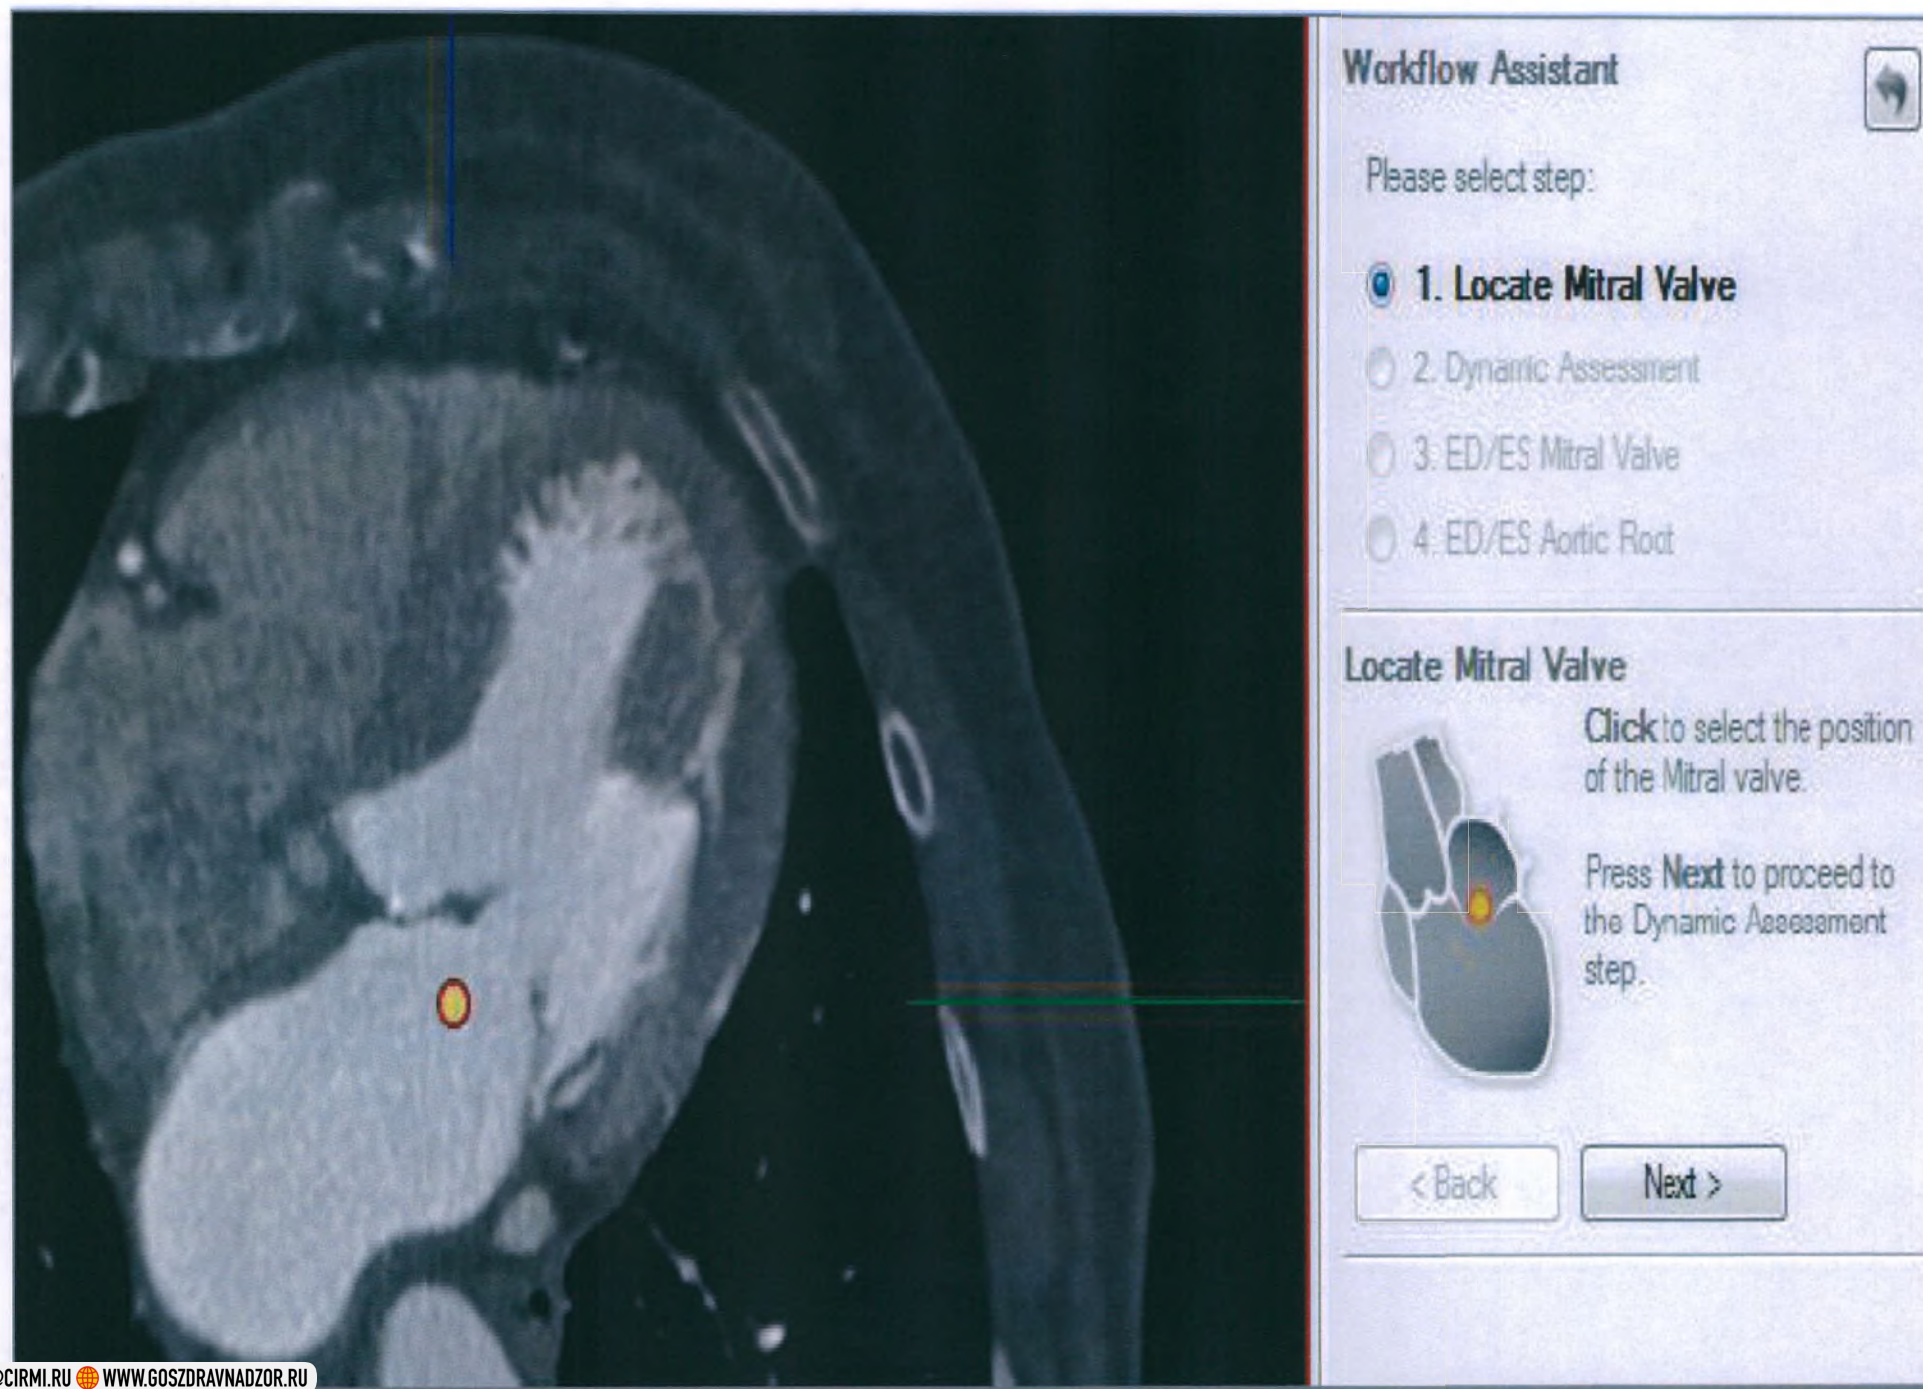


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа ушка левого предсердия;

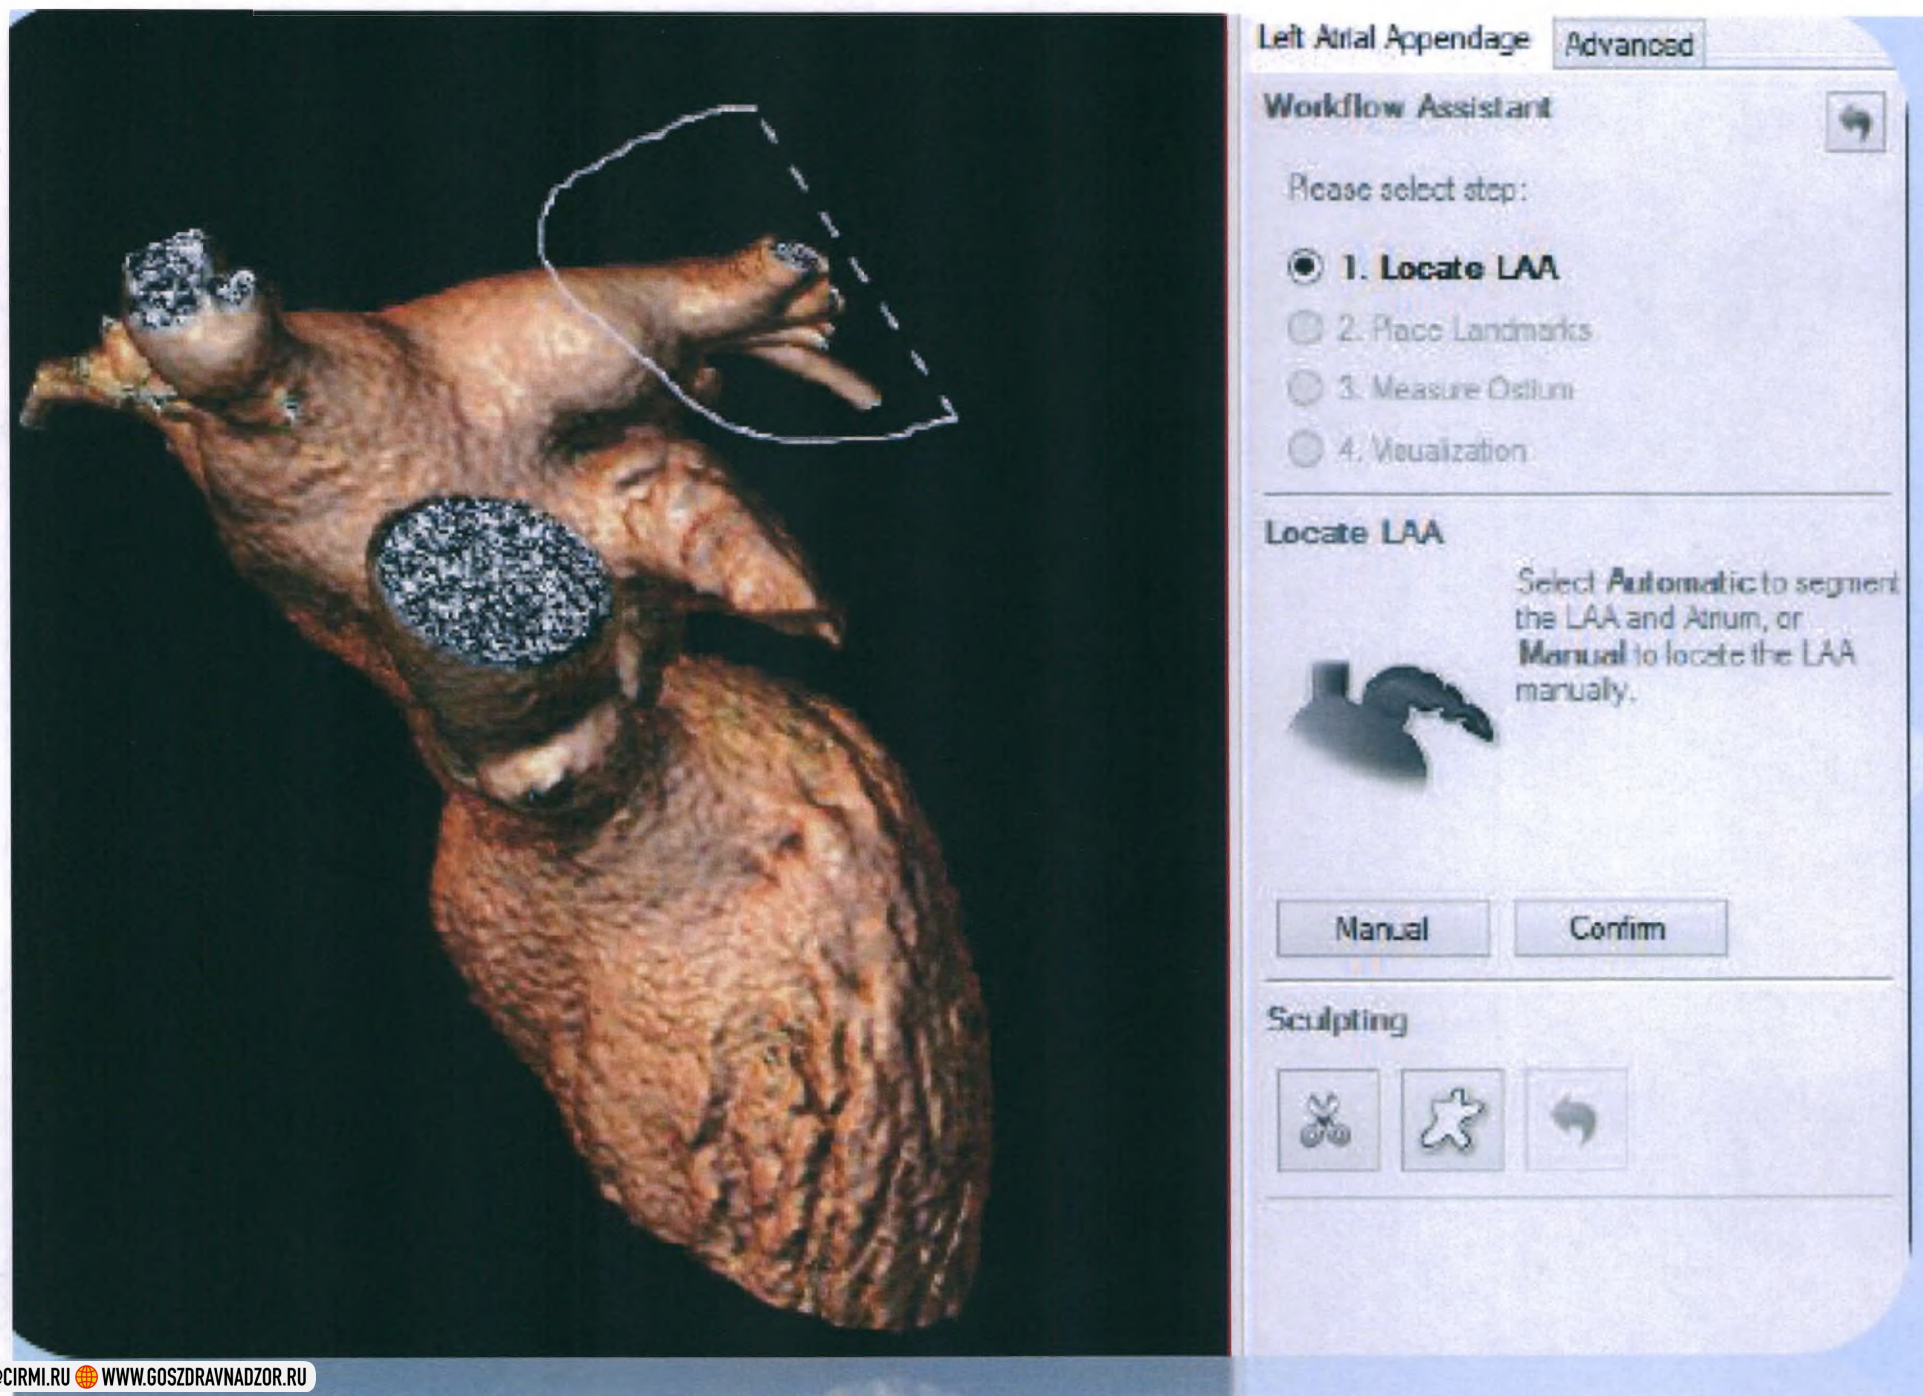

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа регургитации;

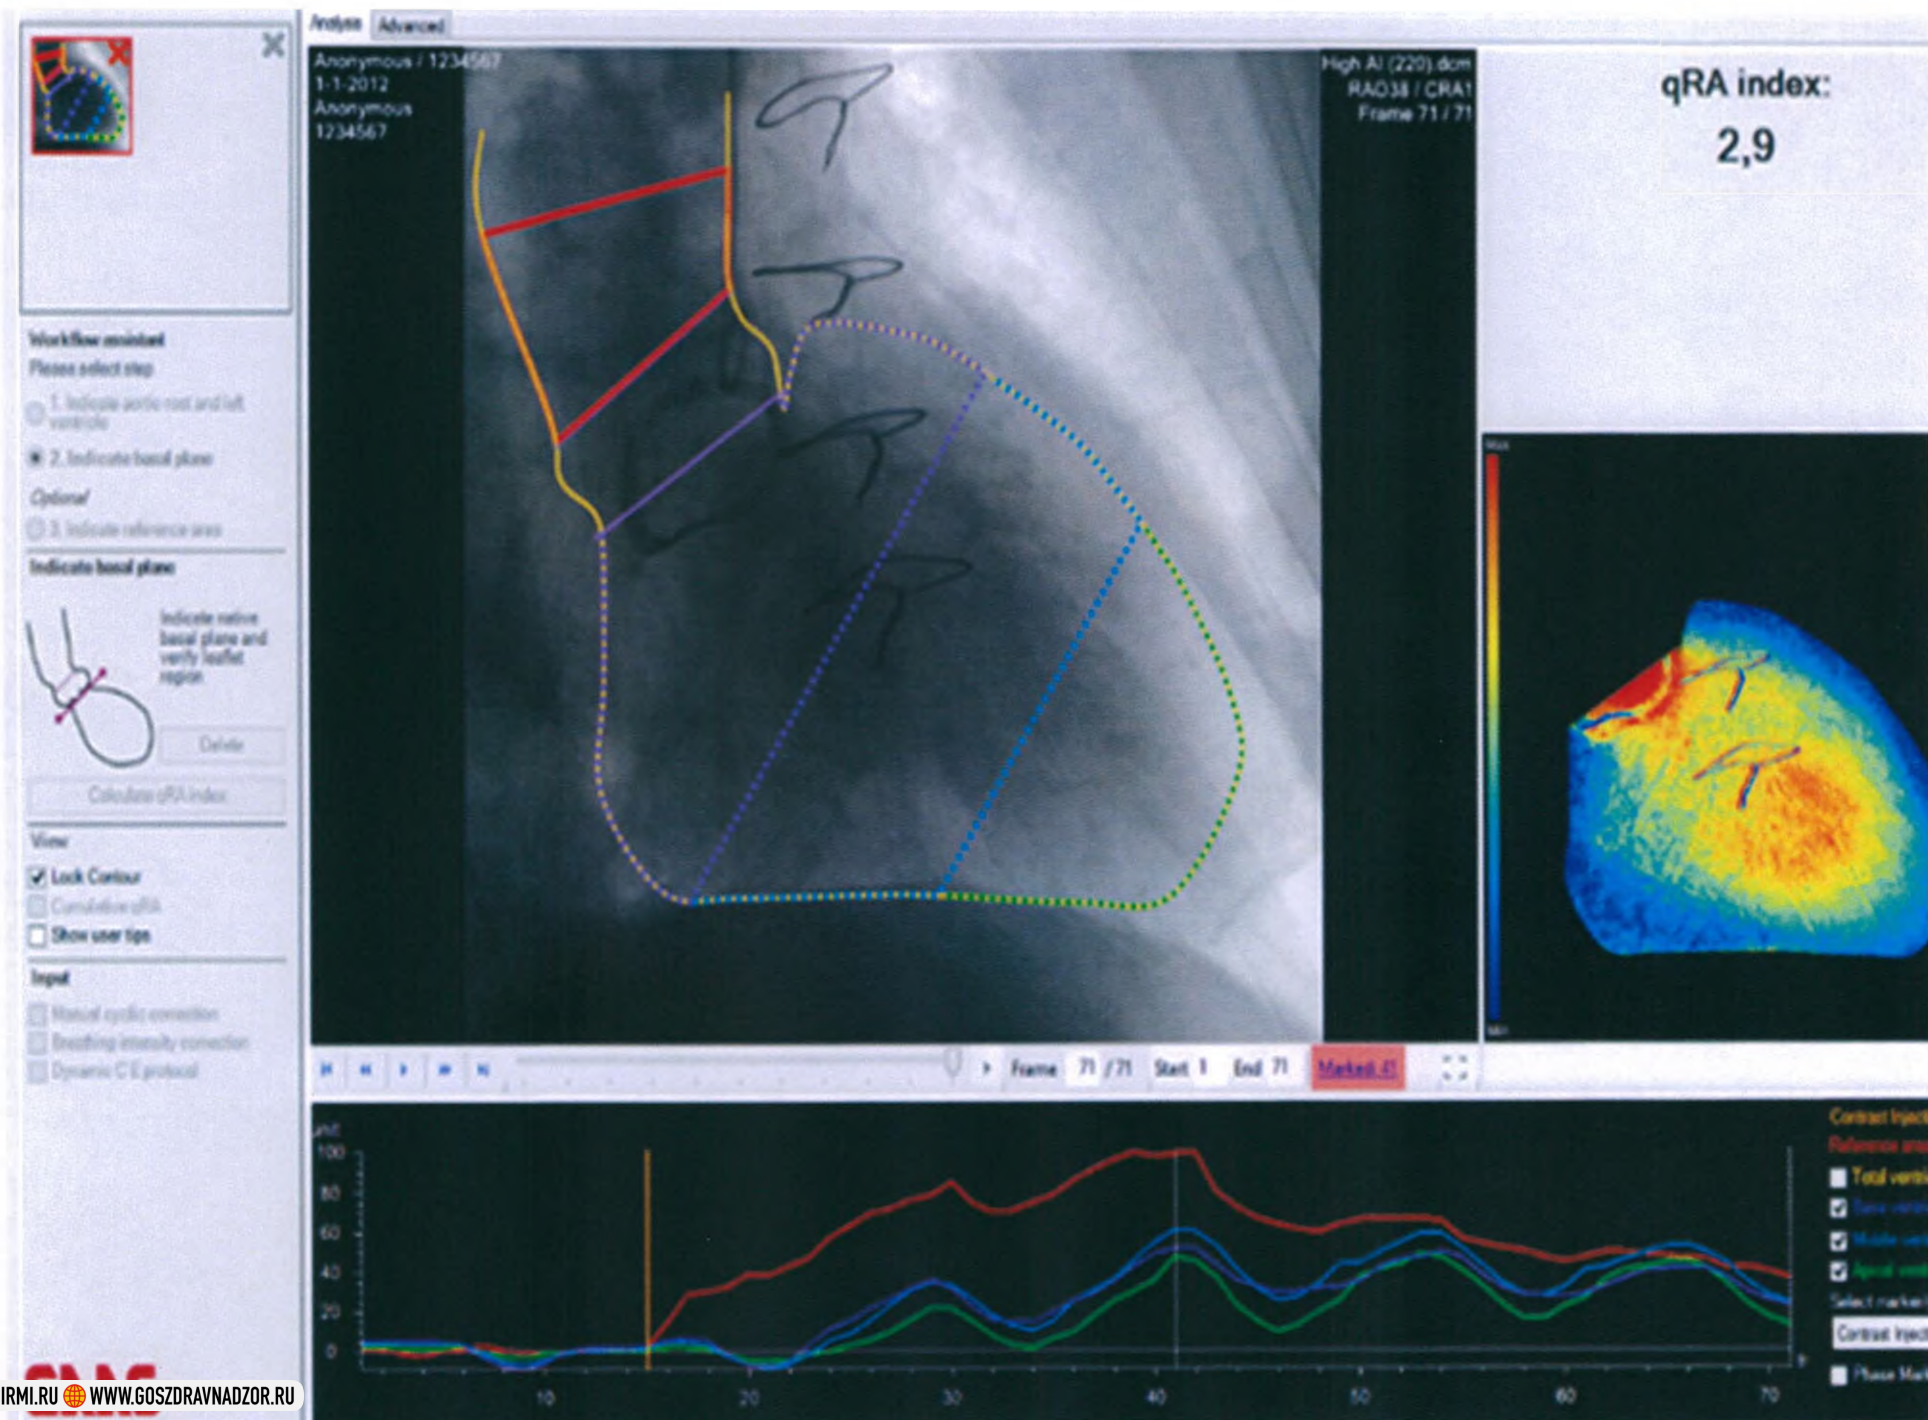


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет DTS для отслеживания дозы;

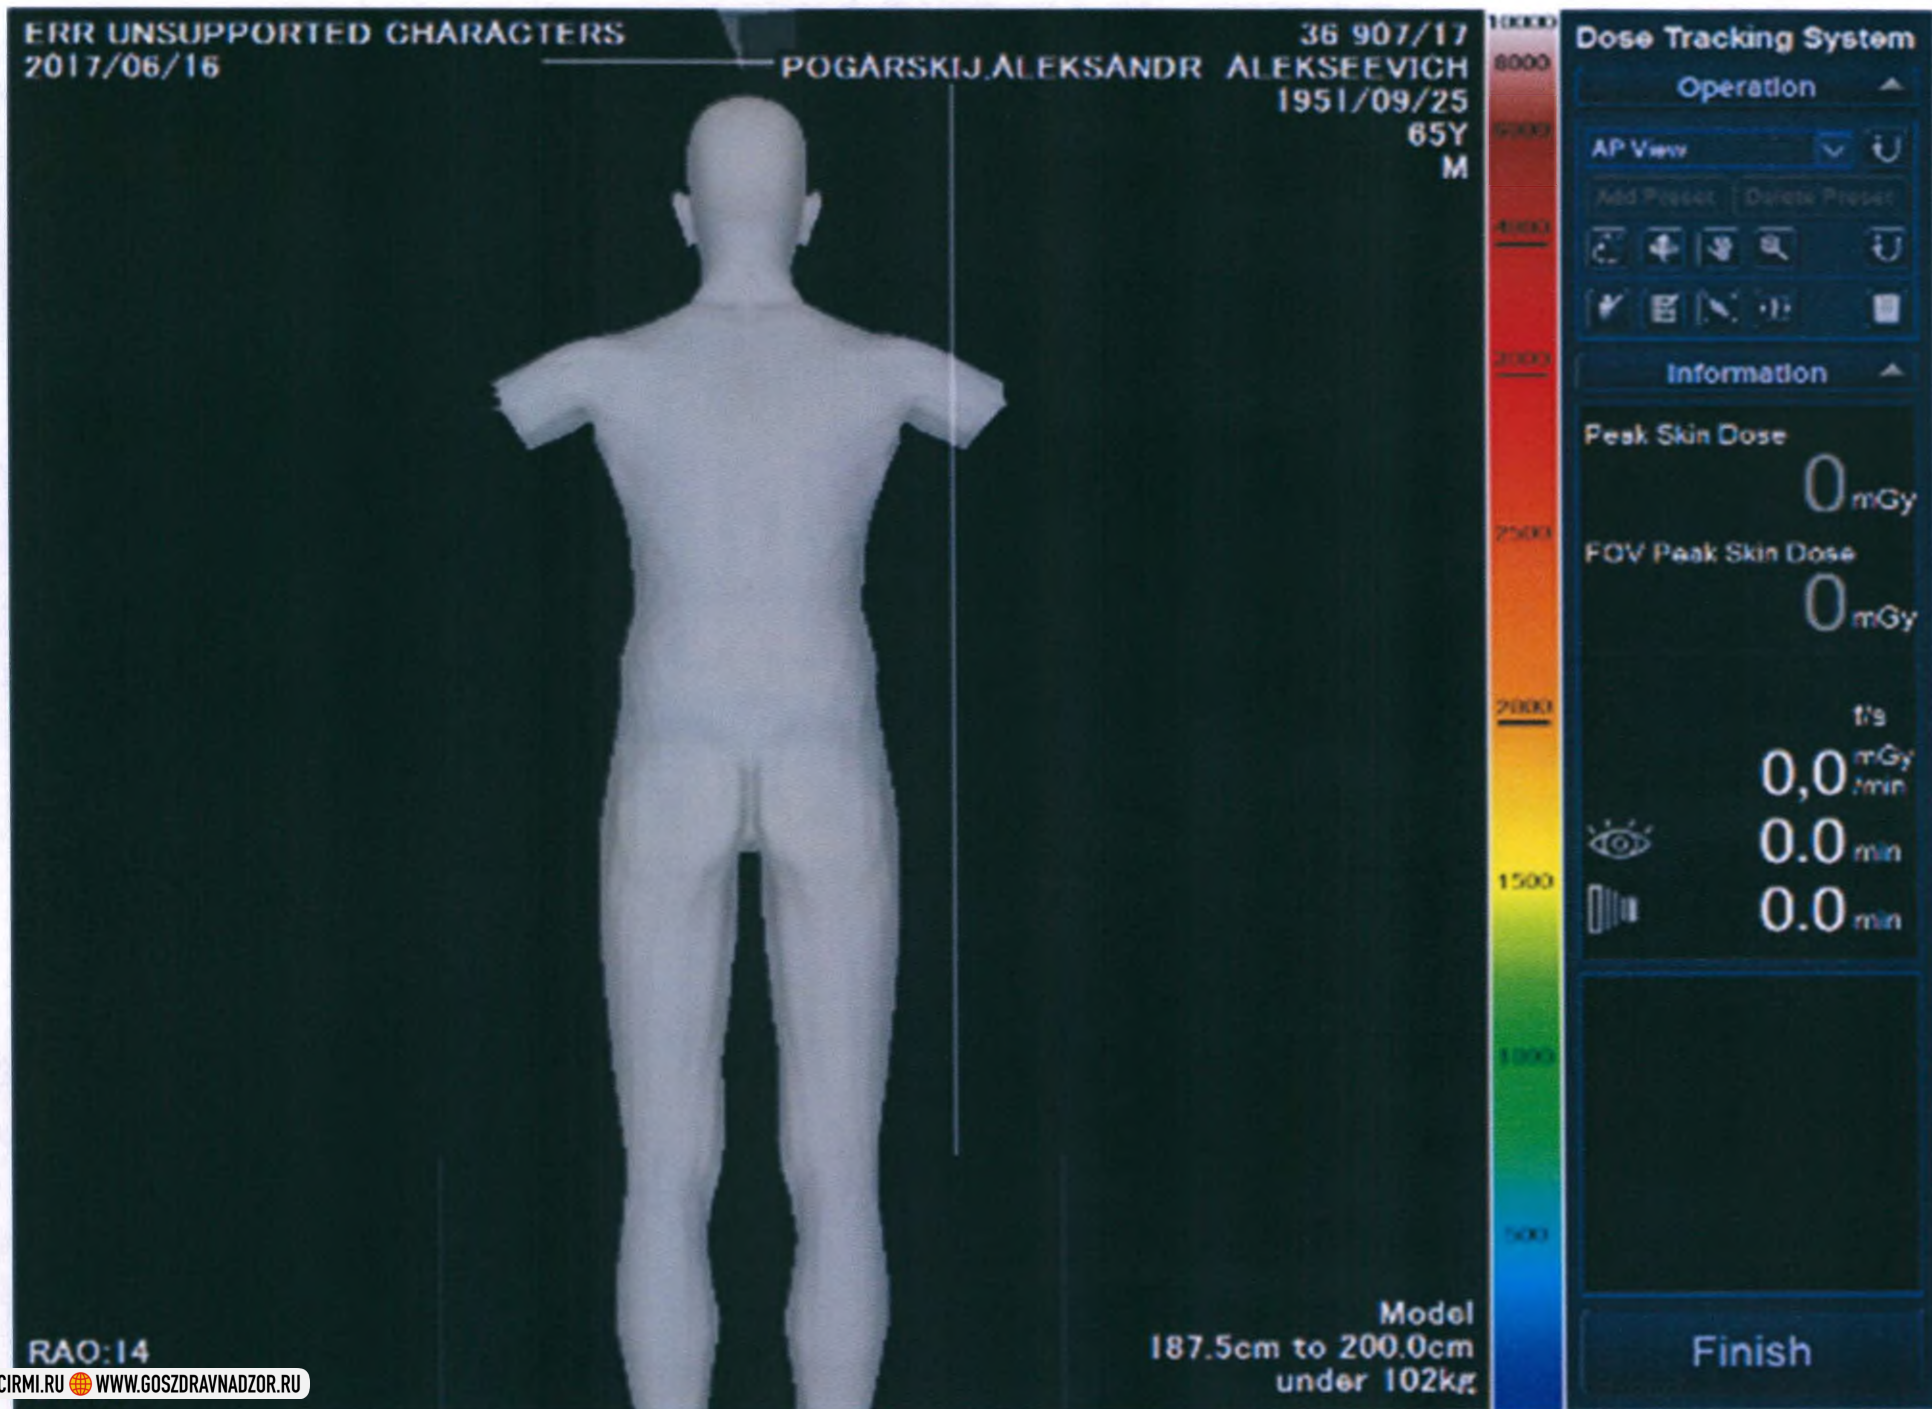

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет динамической стабилизации устройства;



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа аневризмы сосудов головного мозга;

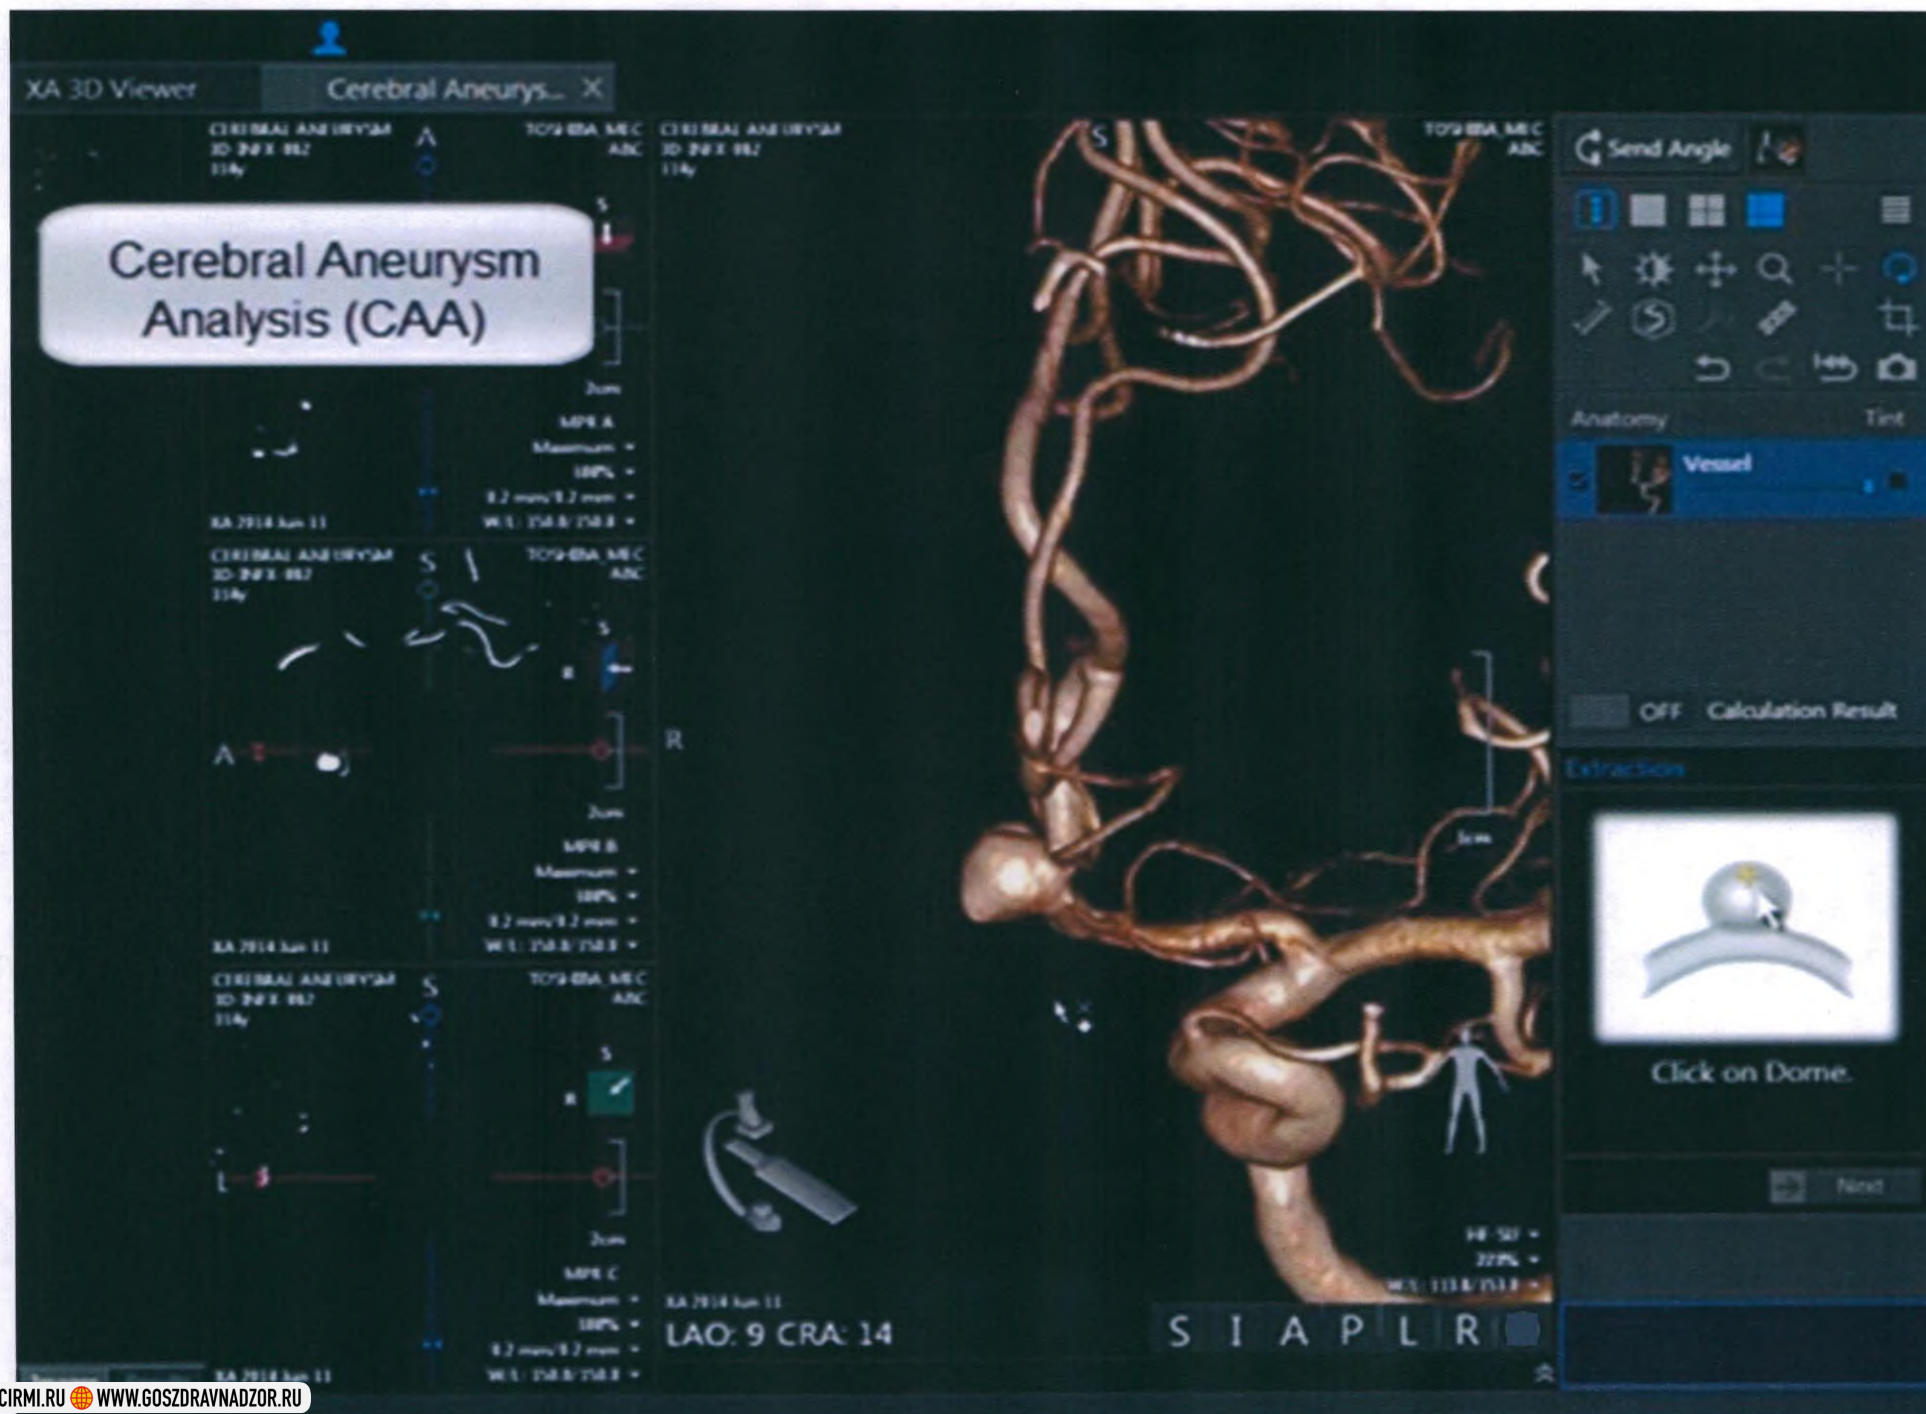


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для планирования эмболизации;




89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет инструментов 3D-просмотра.




90. Комплект для подключения Rocket Link.

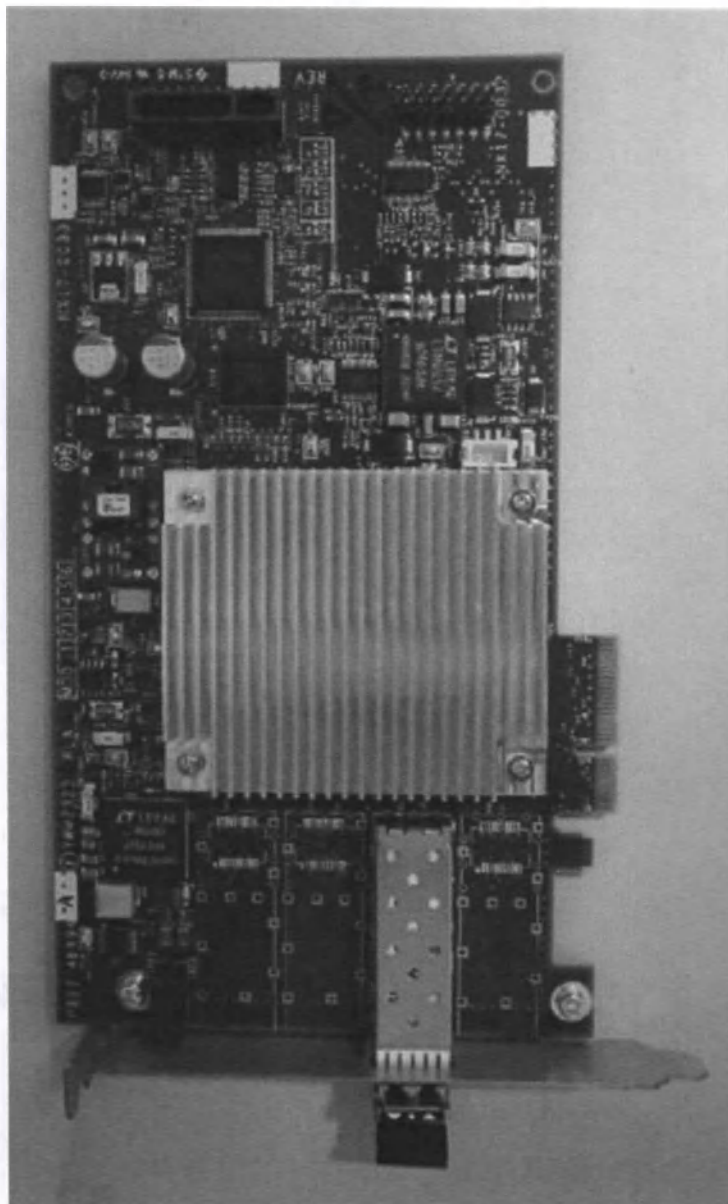


91. Модуль для удаленной сервисной диагностики.

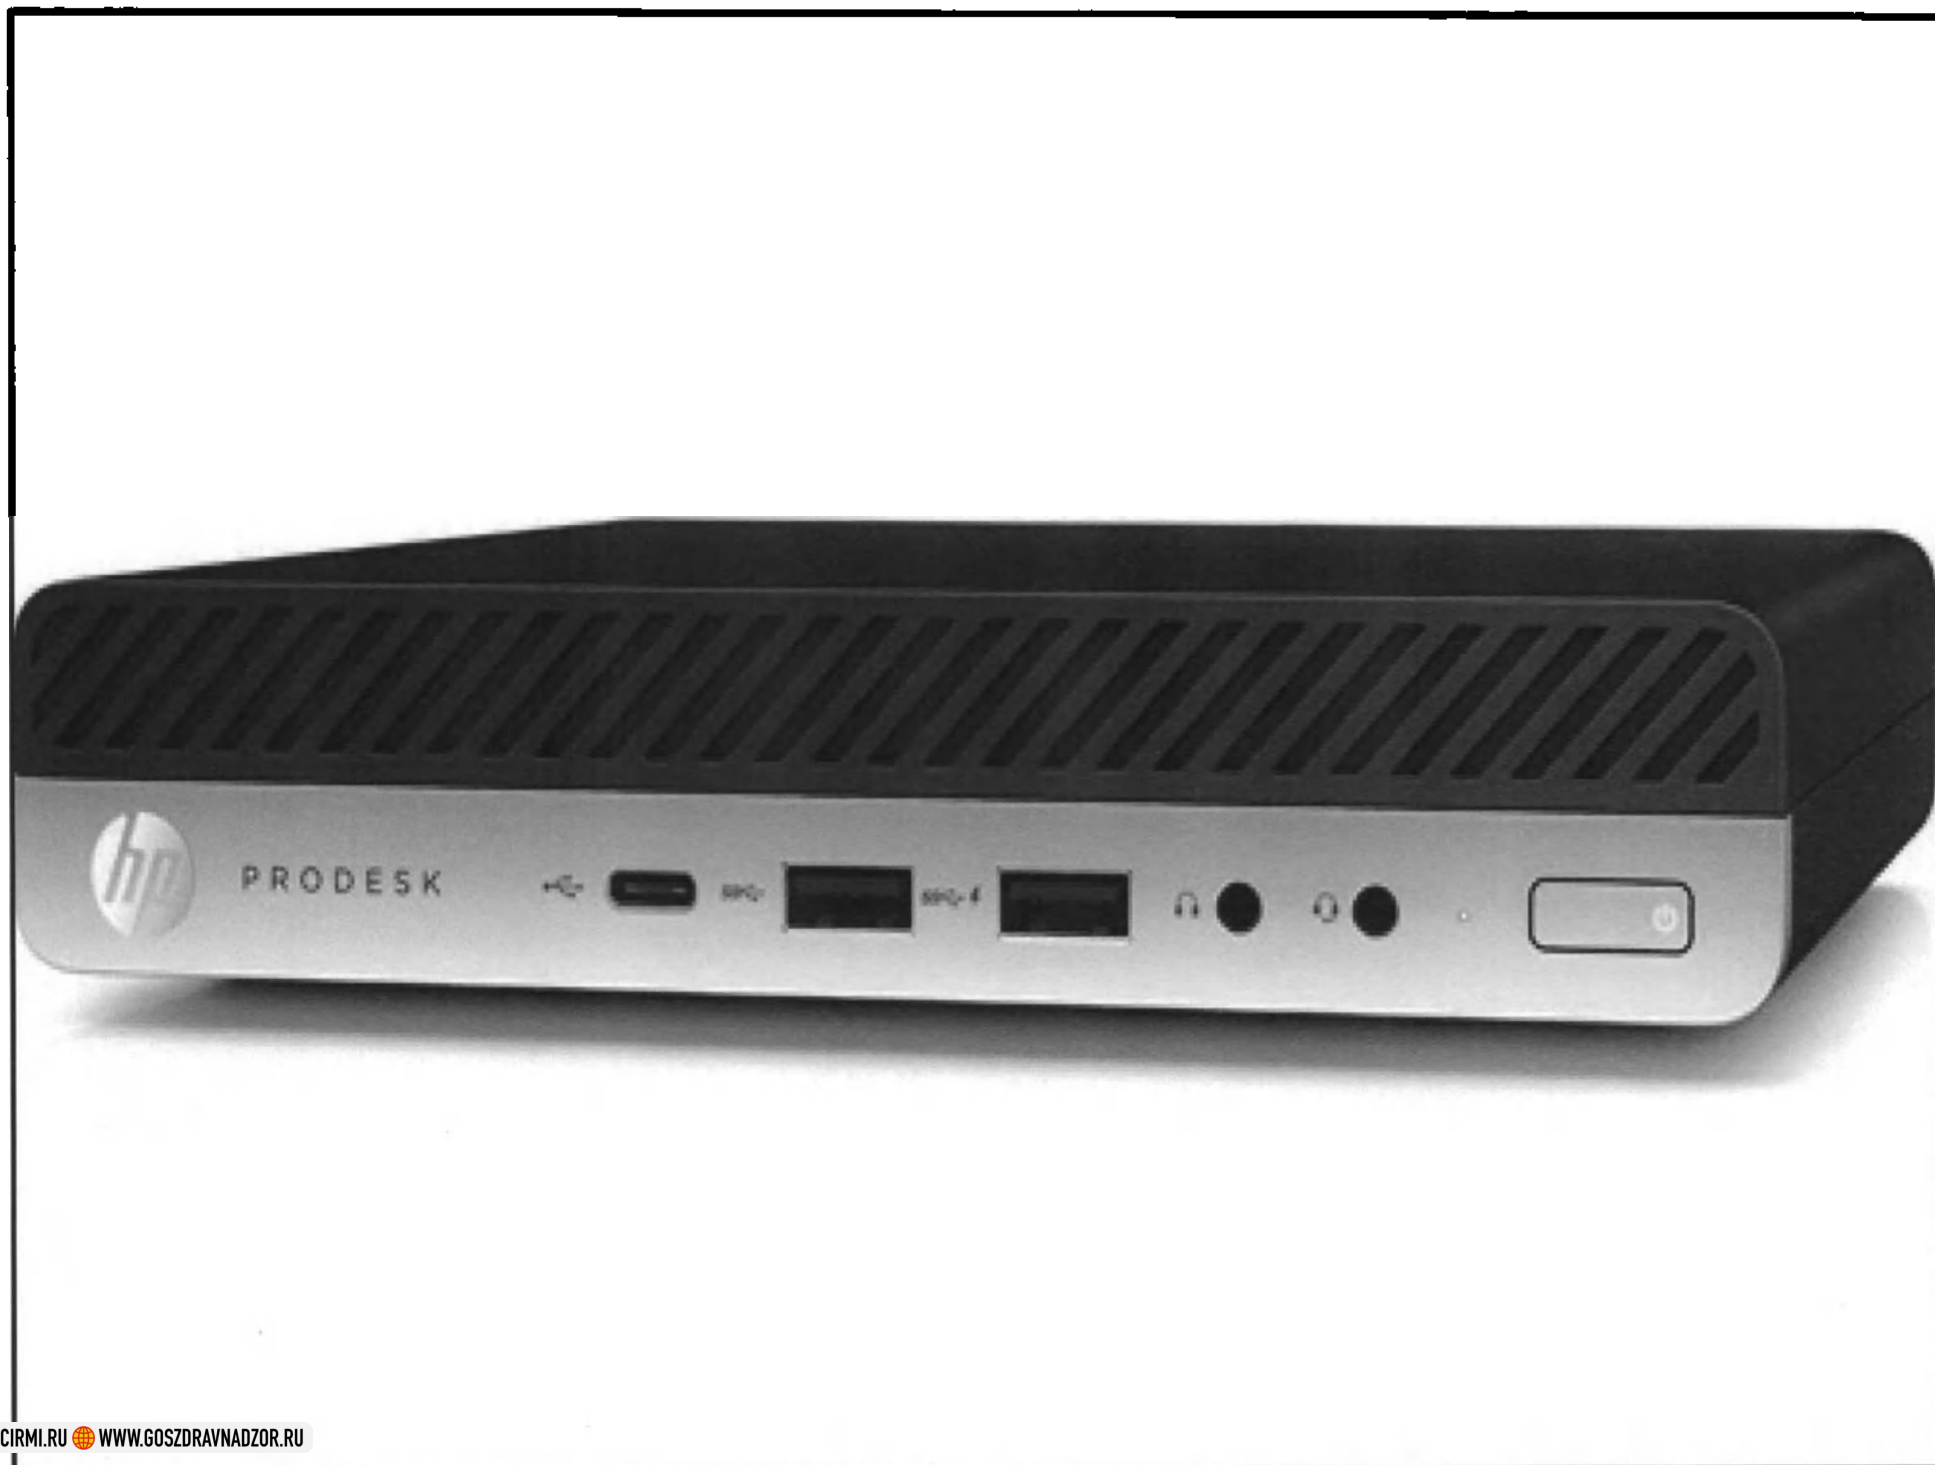


92. Стойка для охладителя.

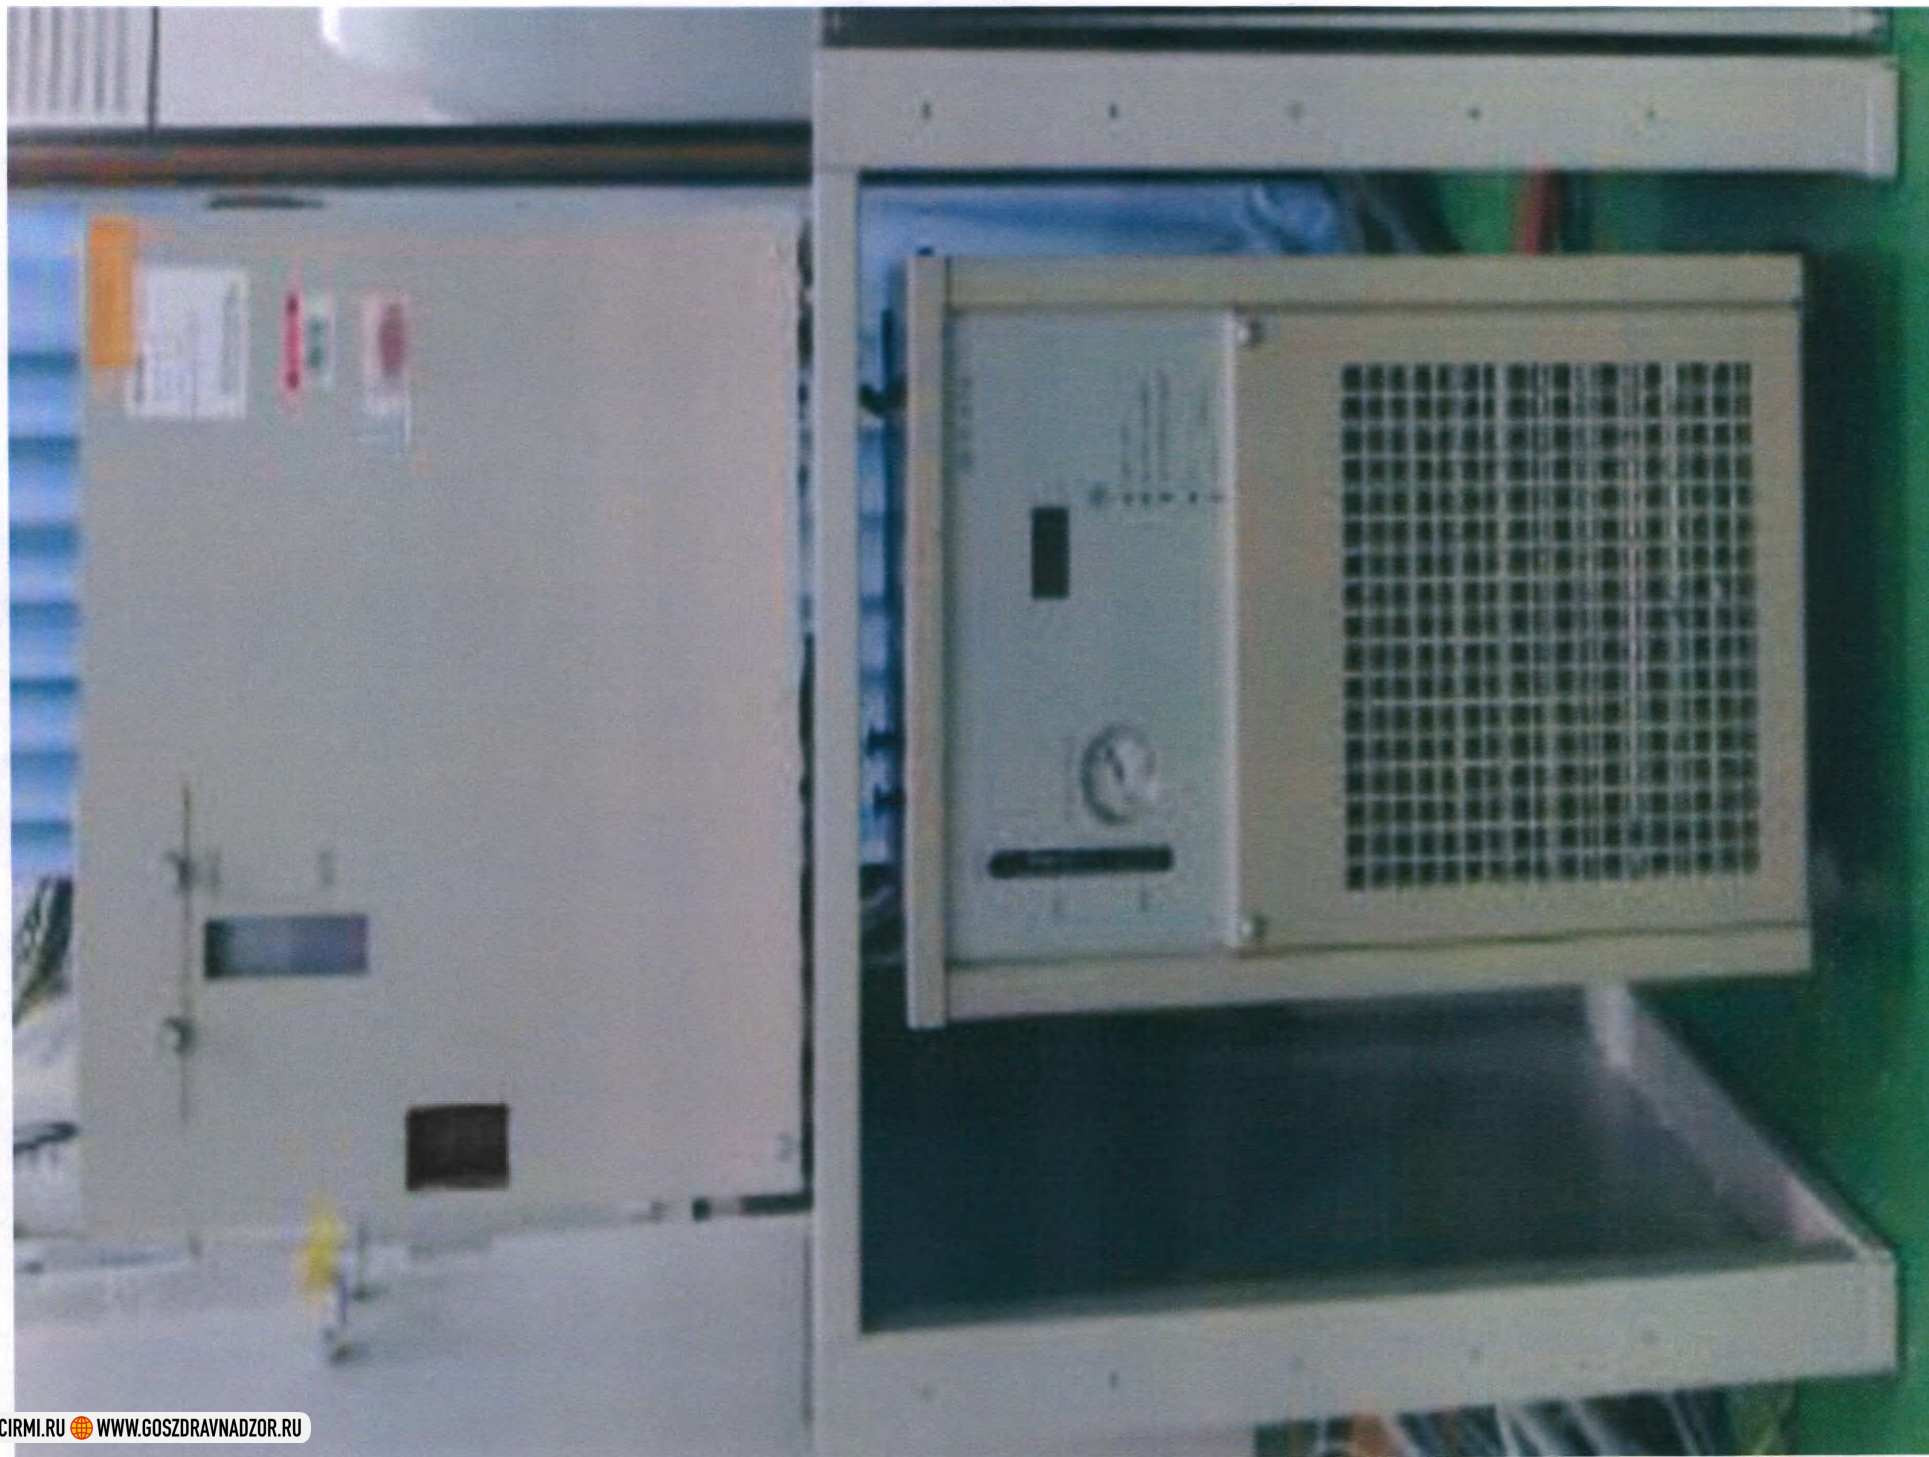

93. Стойка для монитора с большим экраном.

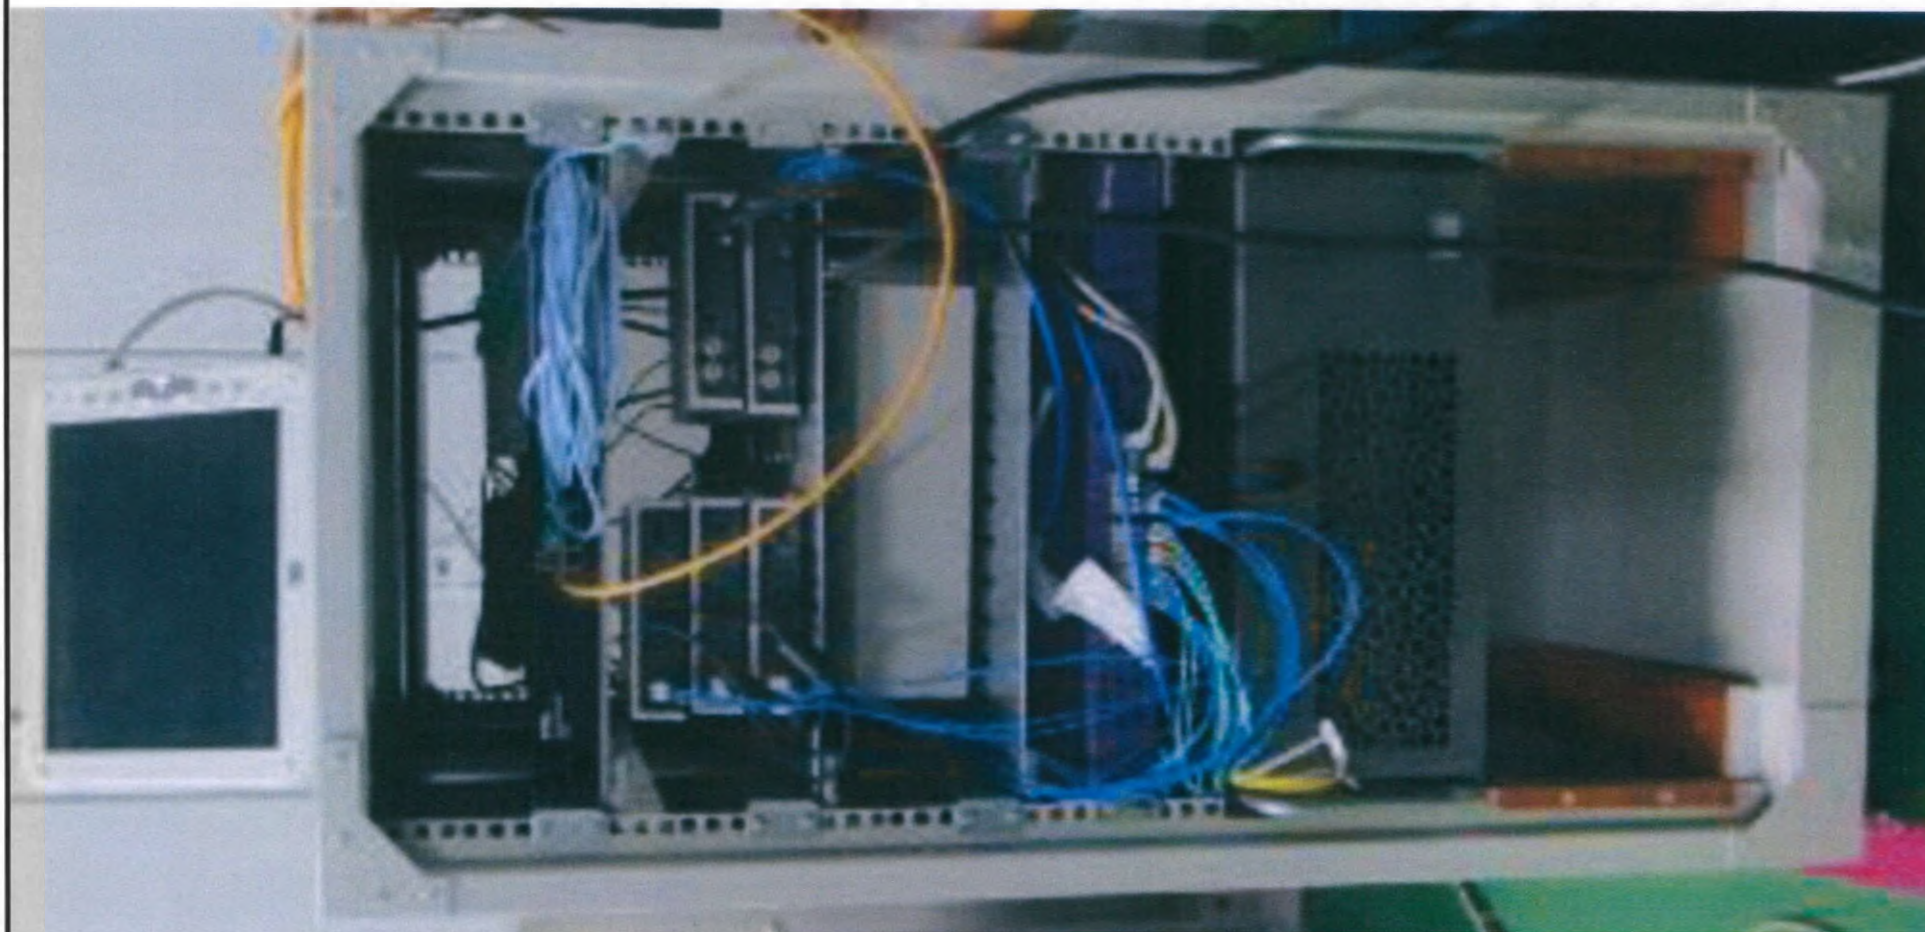




94. Модуль для подключения ИБП.

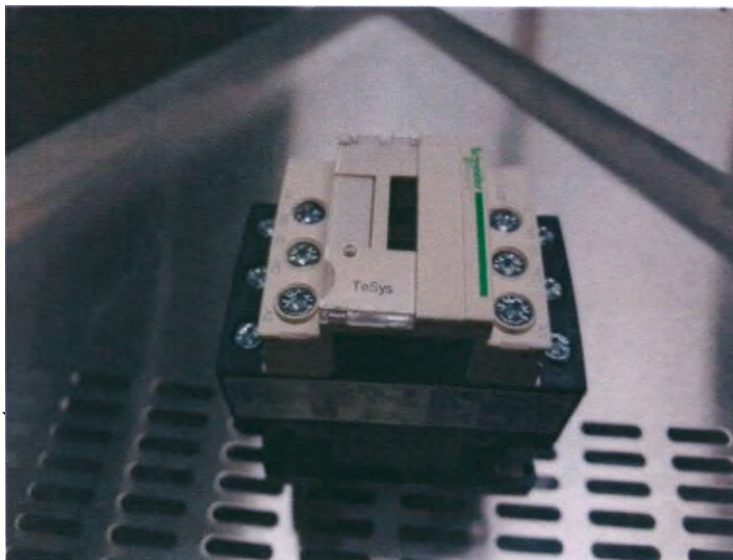

Контактор




Пневматический таймер

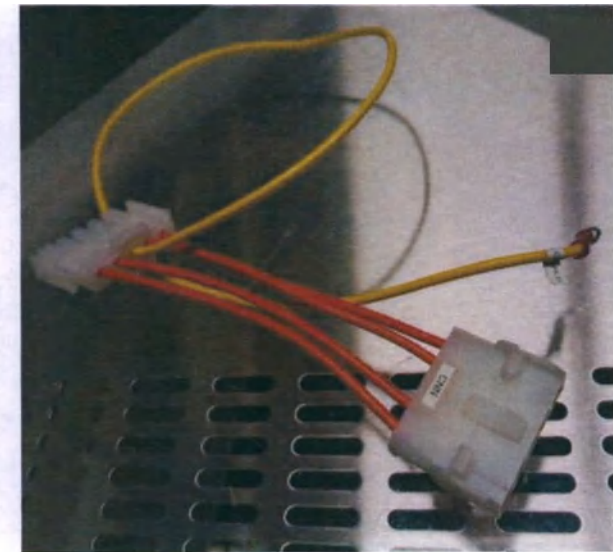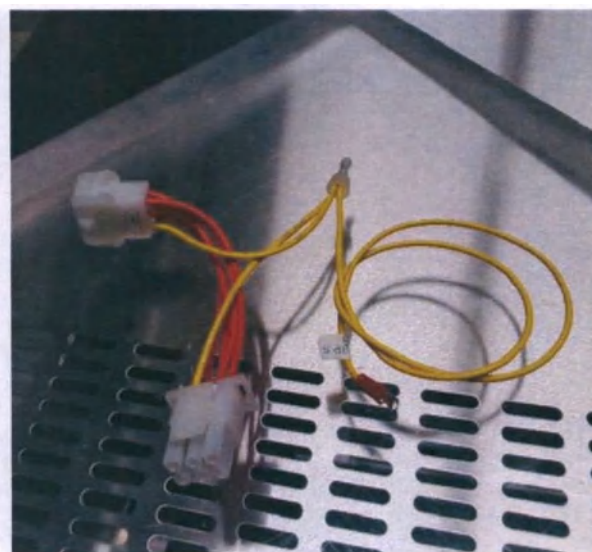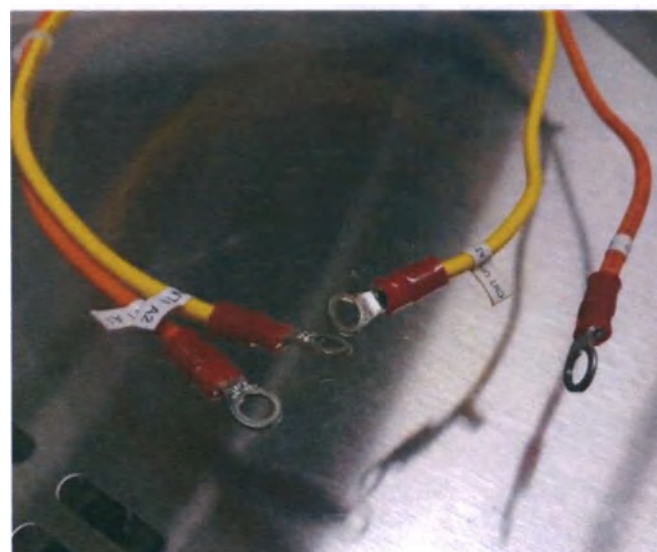


Соединительные кабели

95. ИБП для системы.



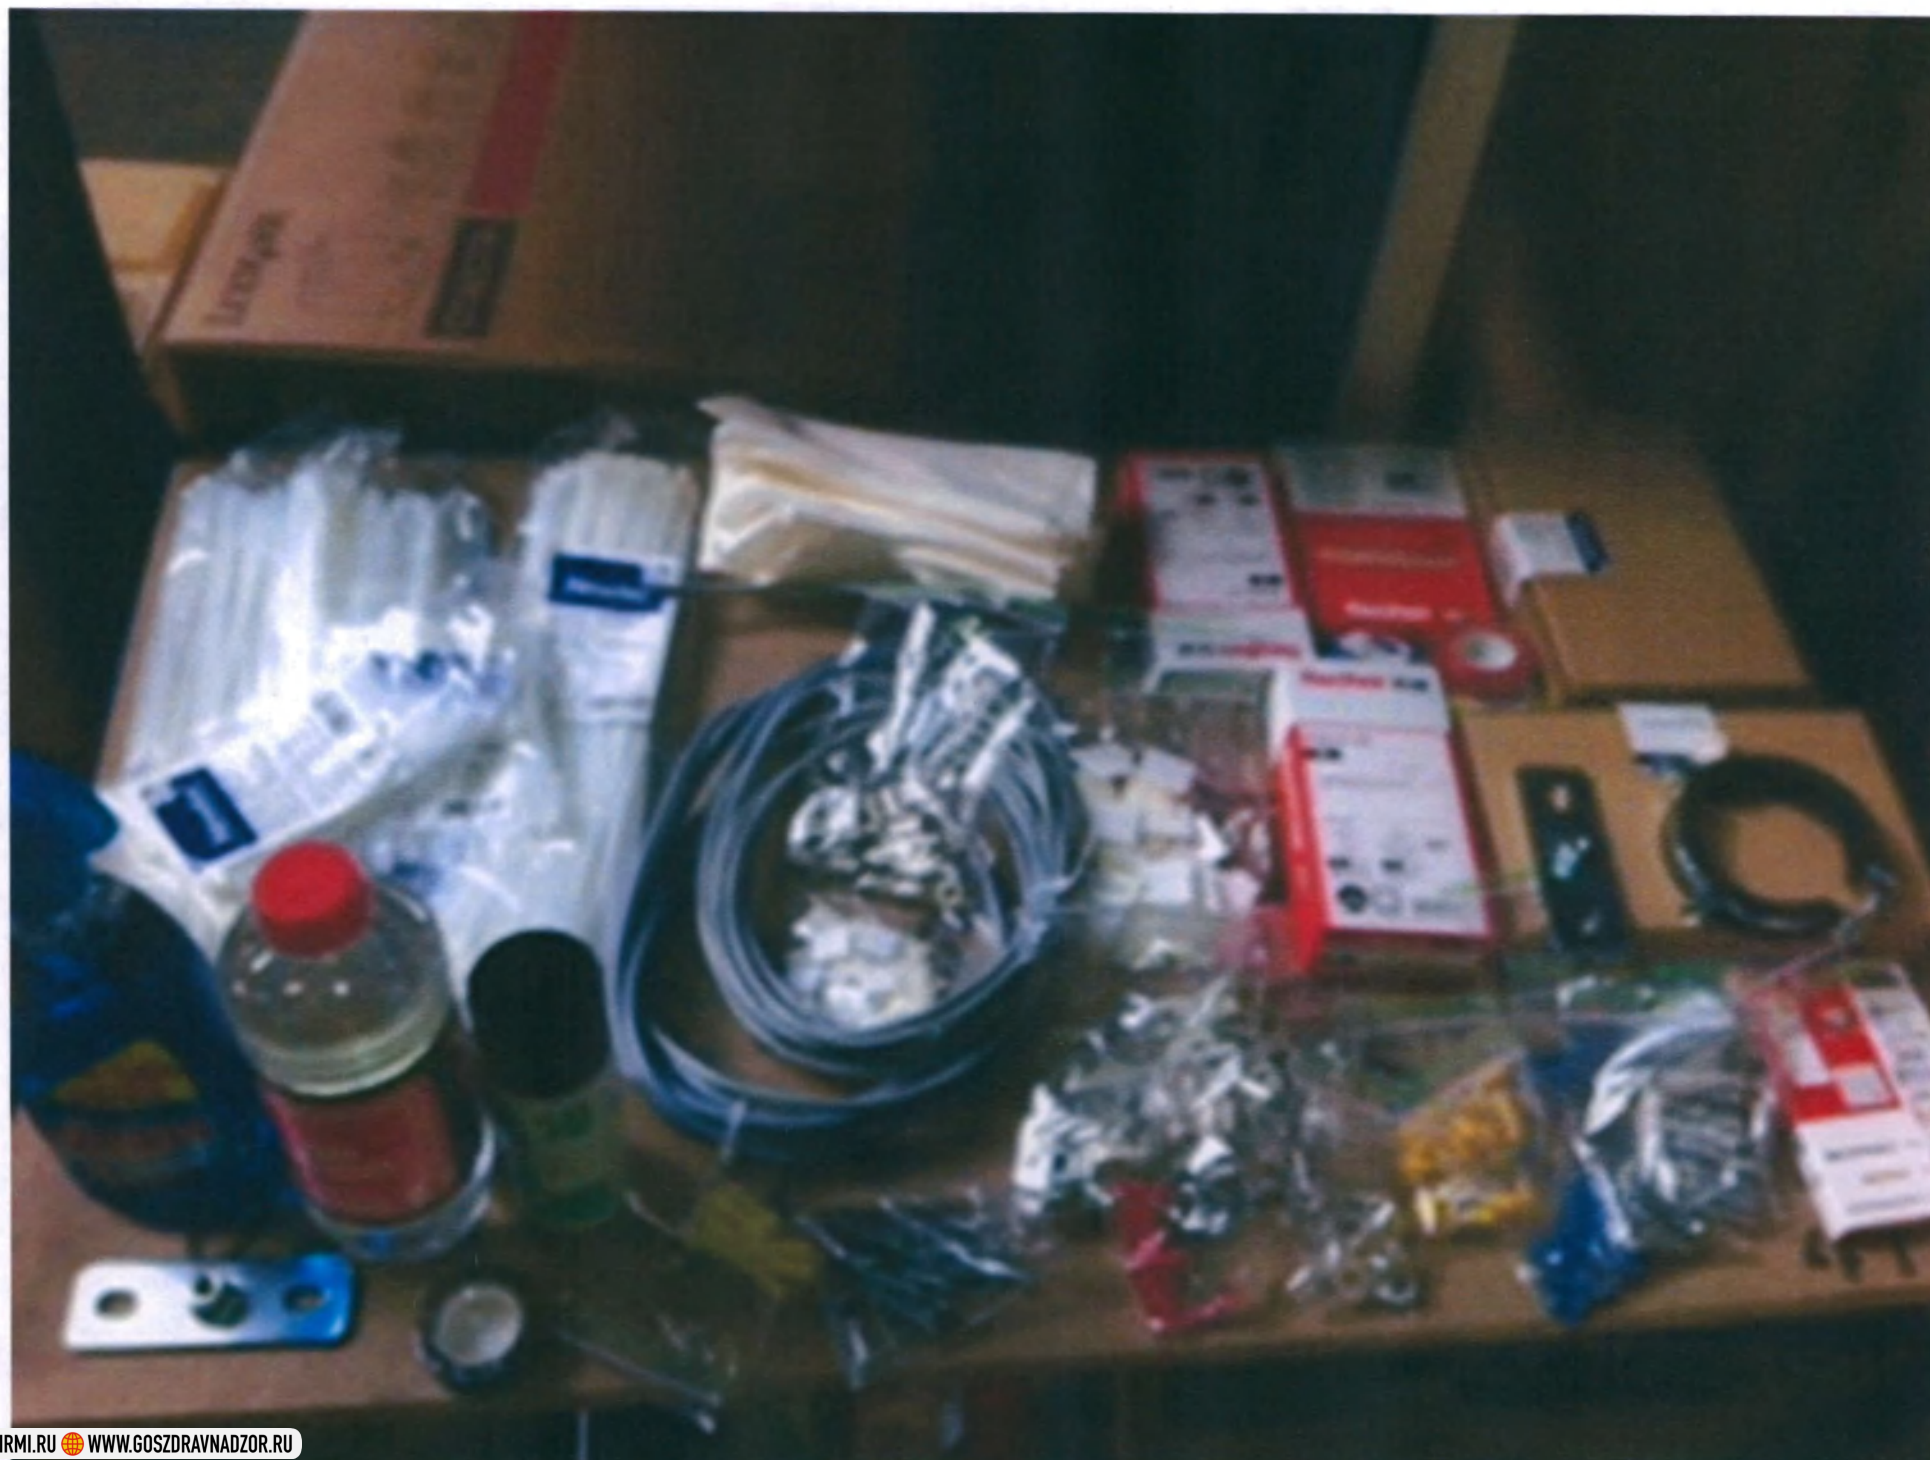

97. Акриловые пластины.

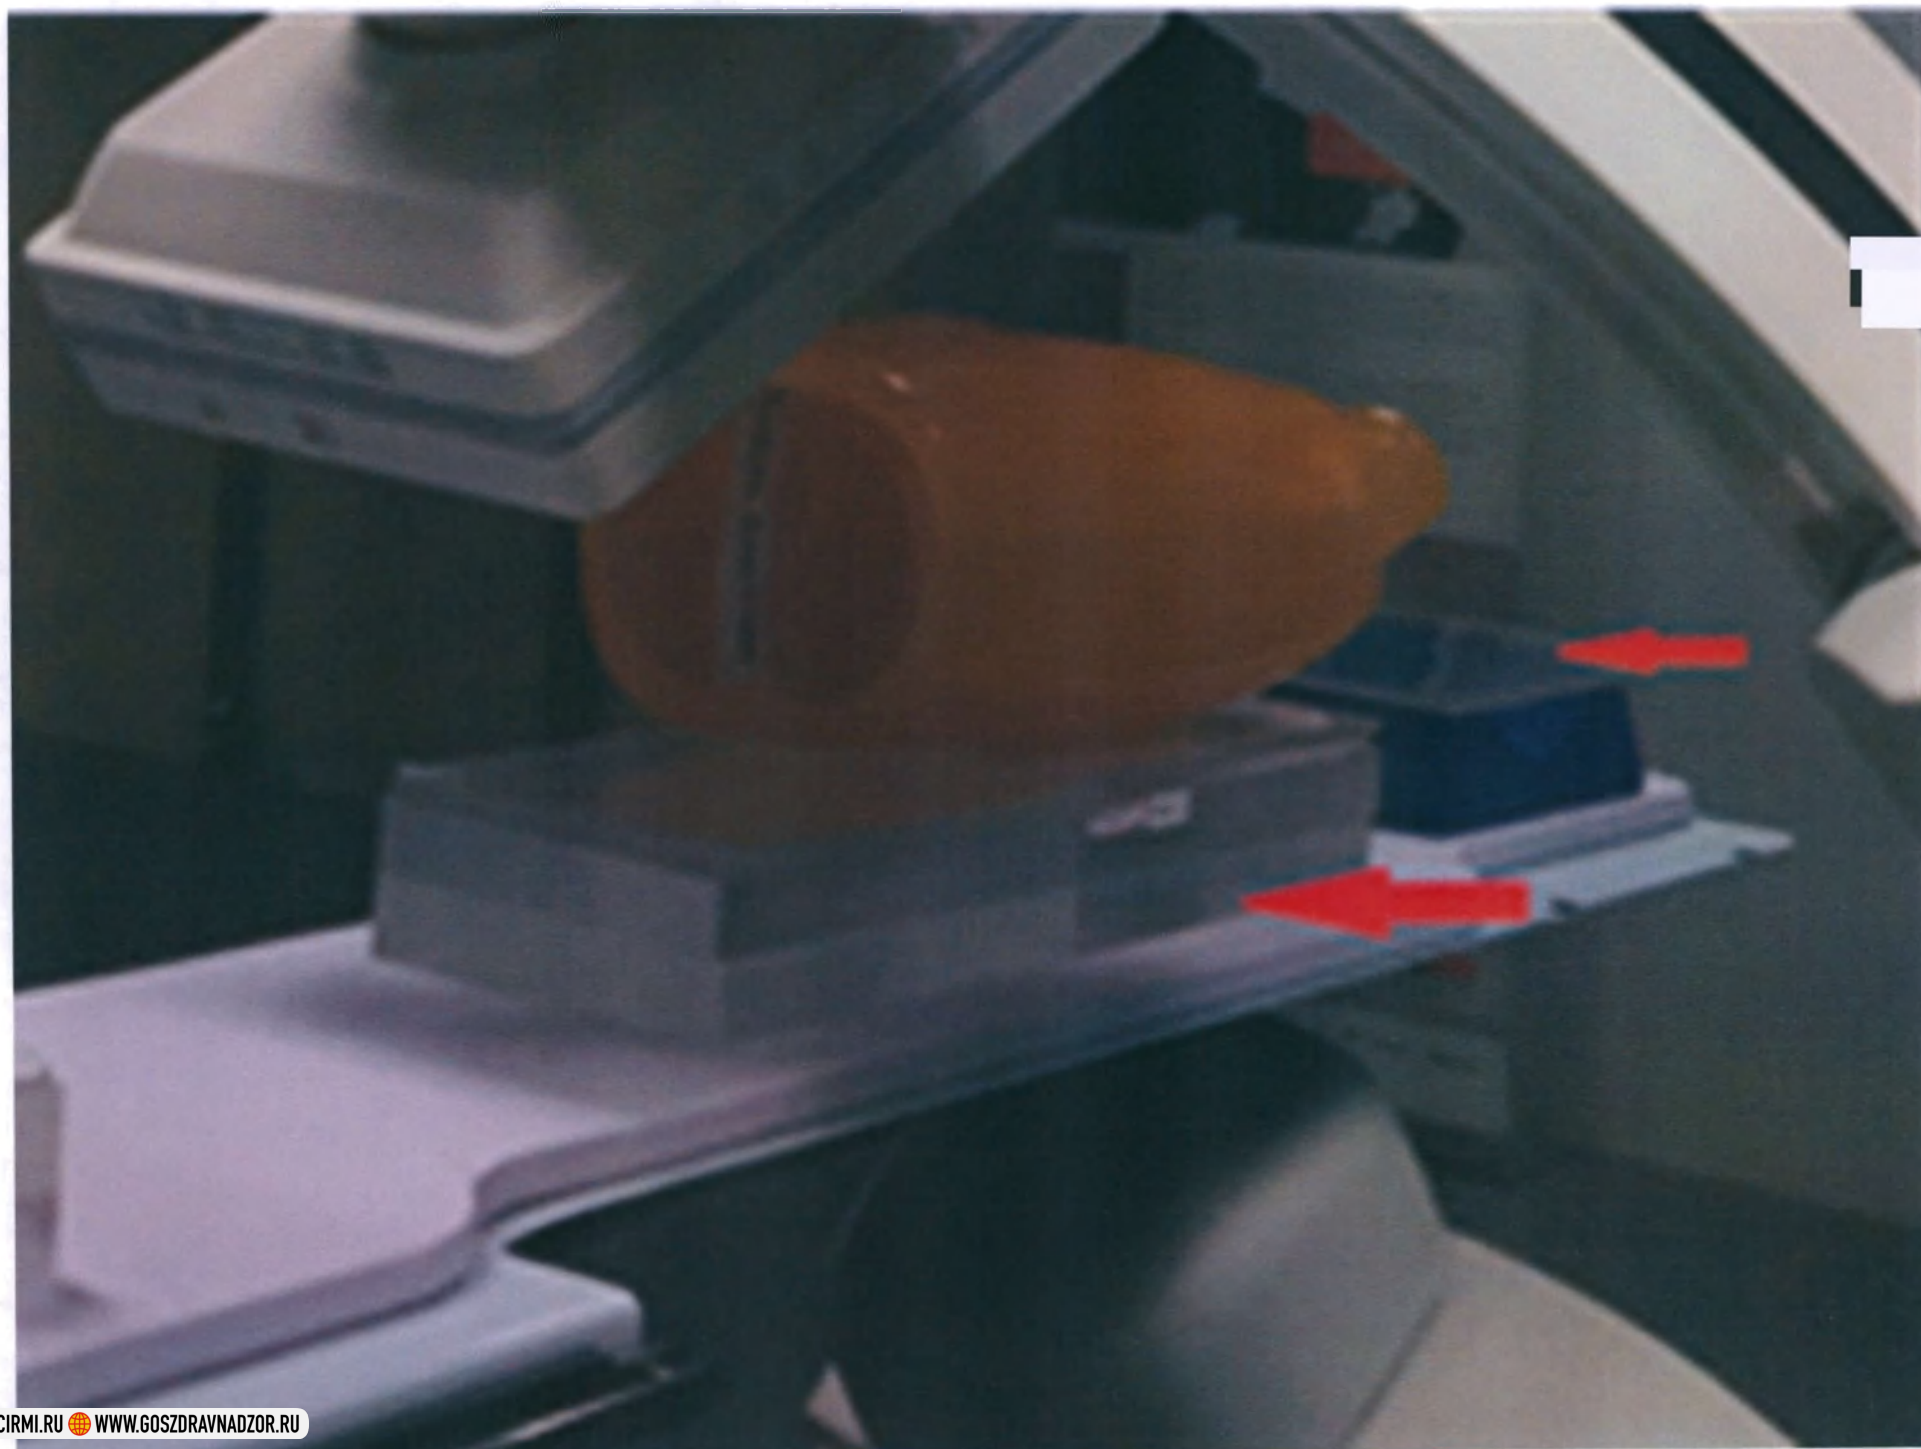

Система кардиологическая ВР интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFX-8000V/Y с принадлежностями.

Основной состав: 1. Напольный опорный модуль С-дуги модели CAS-880A.




2. Потолочный подвесной опорный модуль Ω -дуги.




3. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, в вариантах исполнения: - модель BLA-900C - 2 шт.




3. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, в вариантах исполнения: - модель BLA-900C/R1 - 2 шт.

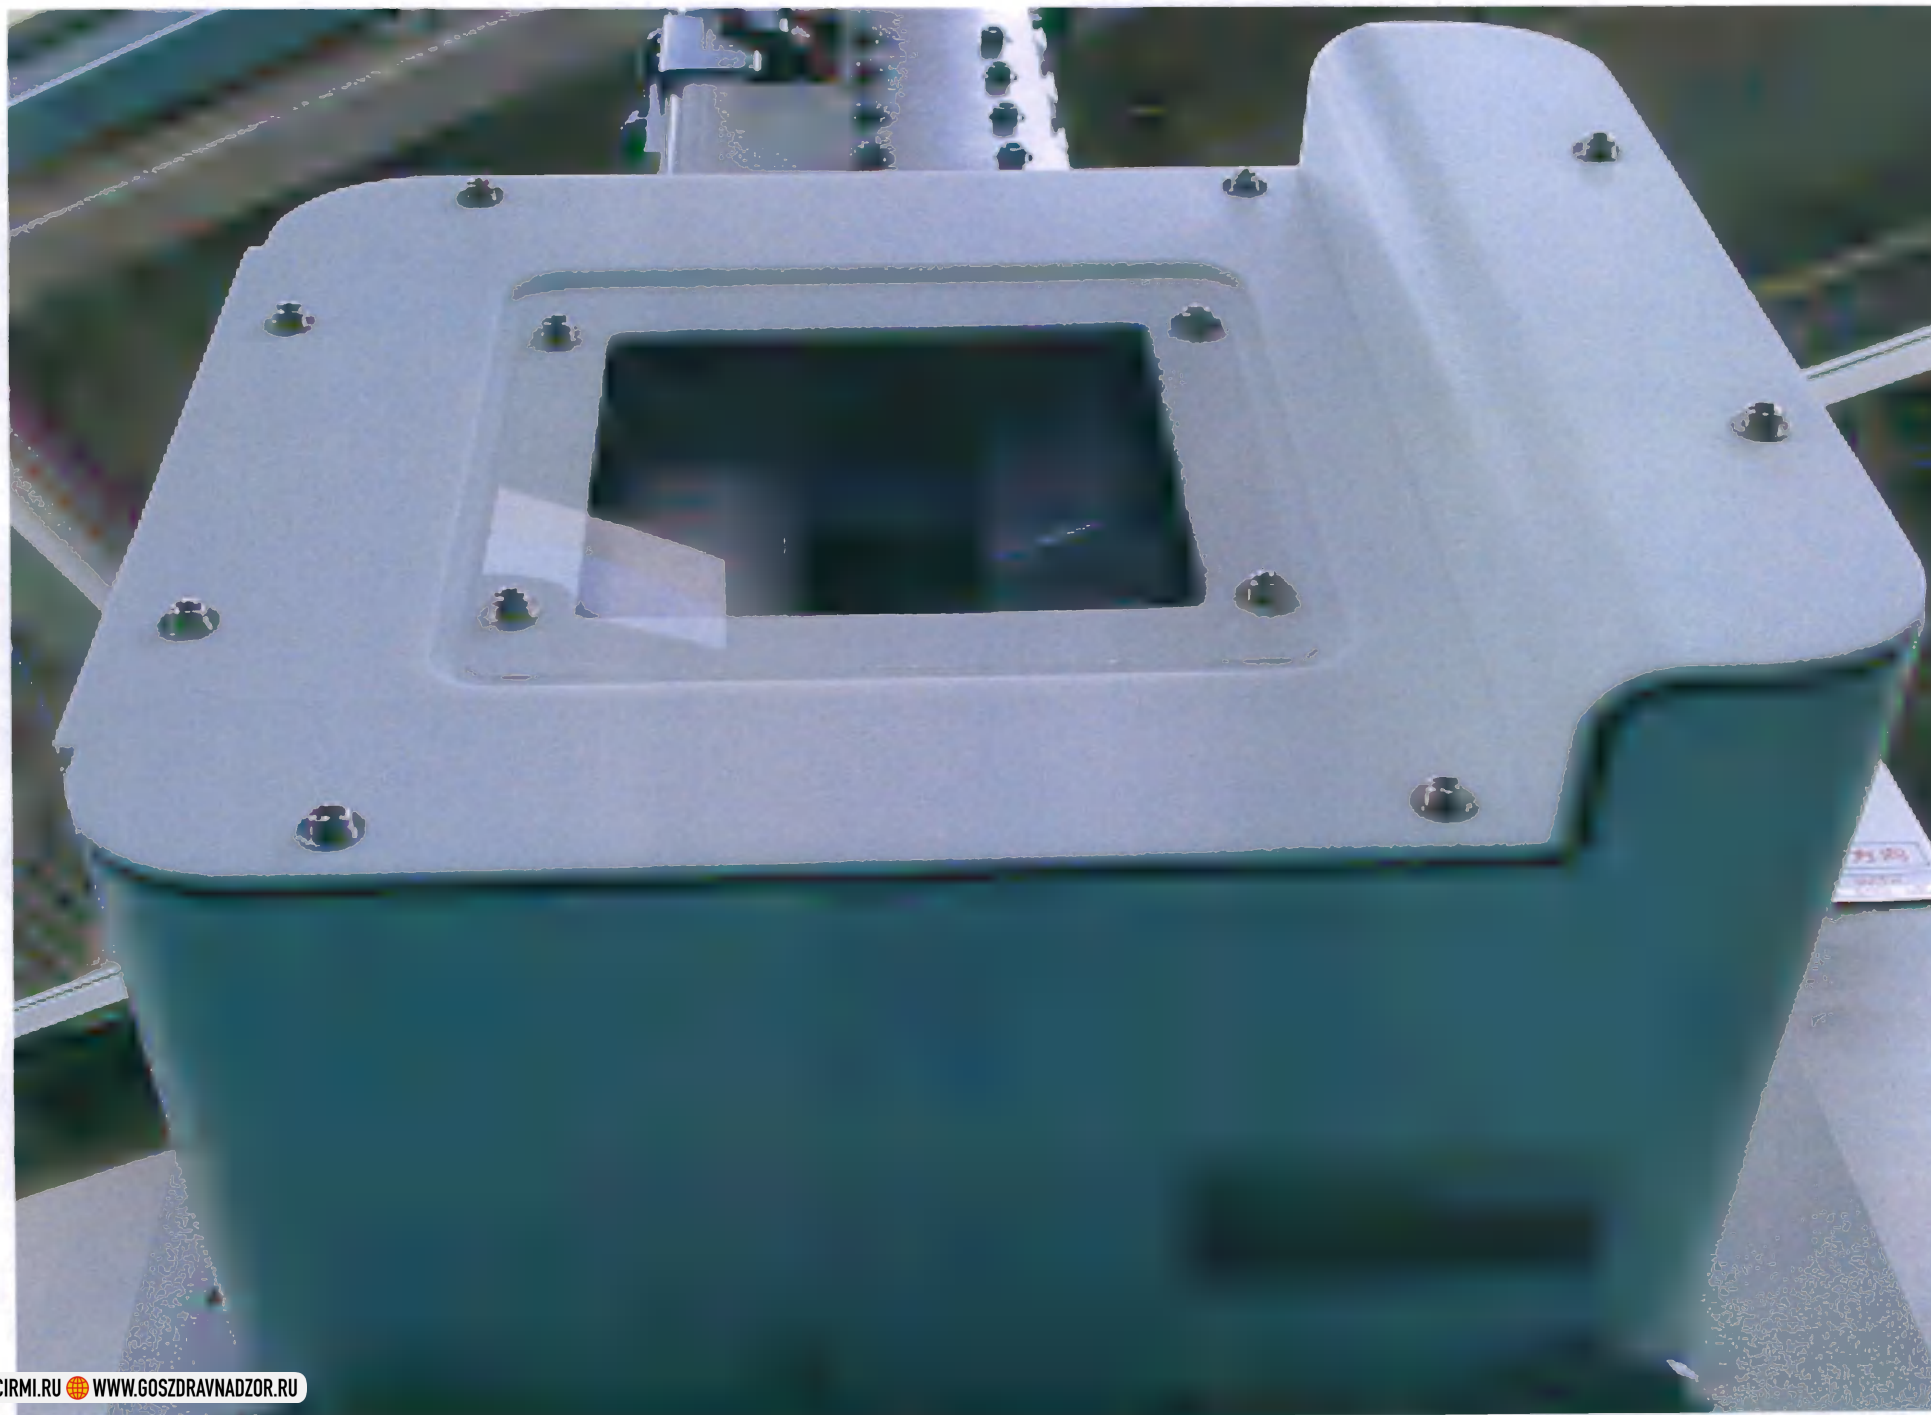


4. Узел рентгеновской трубки, модель DSRX-T7444GDS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония) - 2 шт.

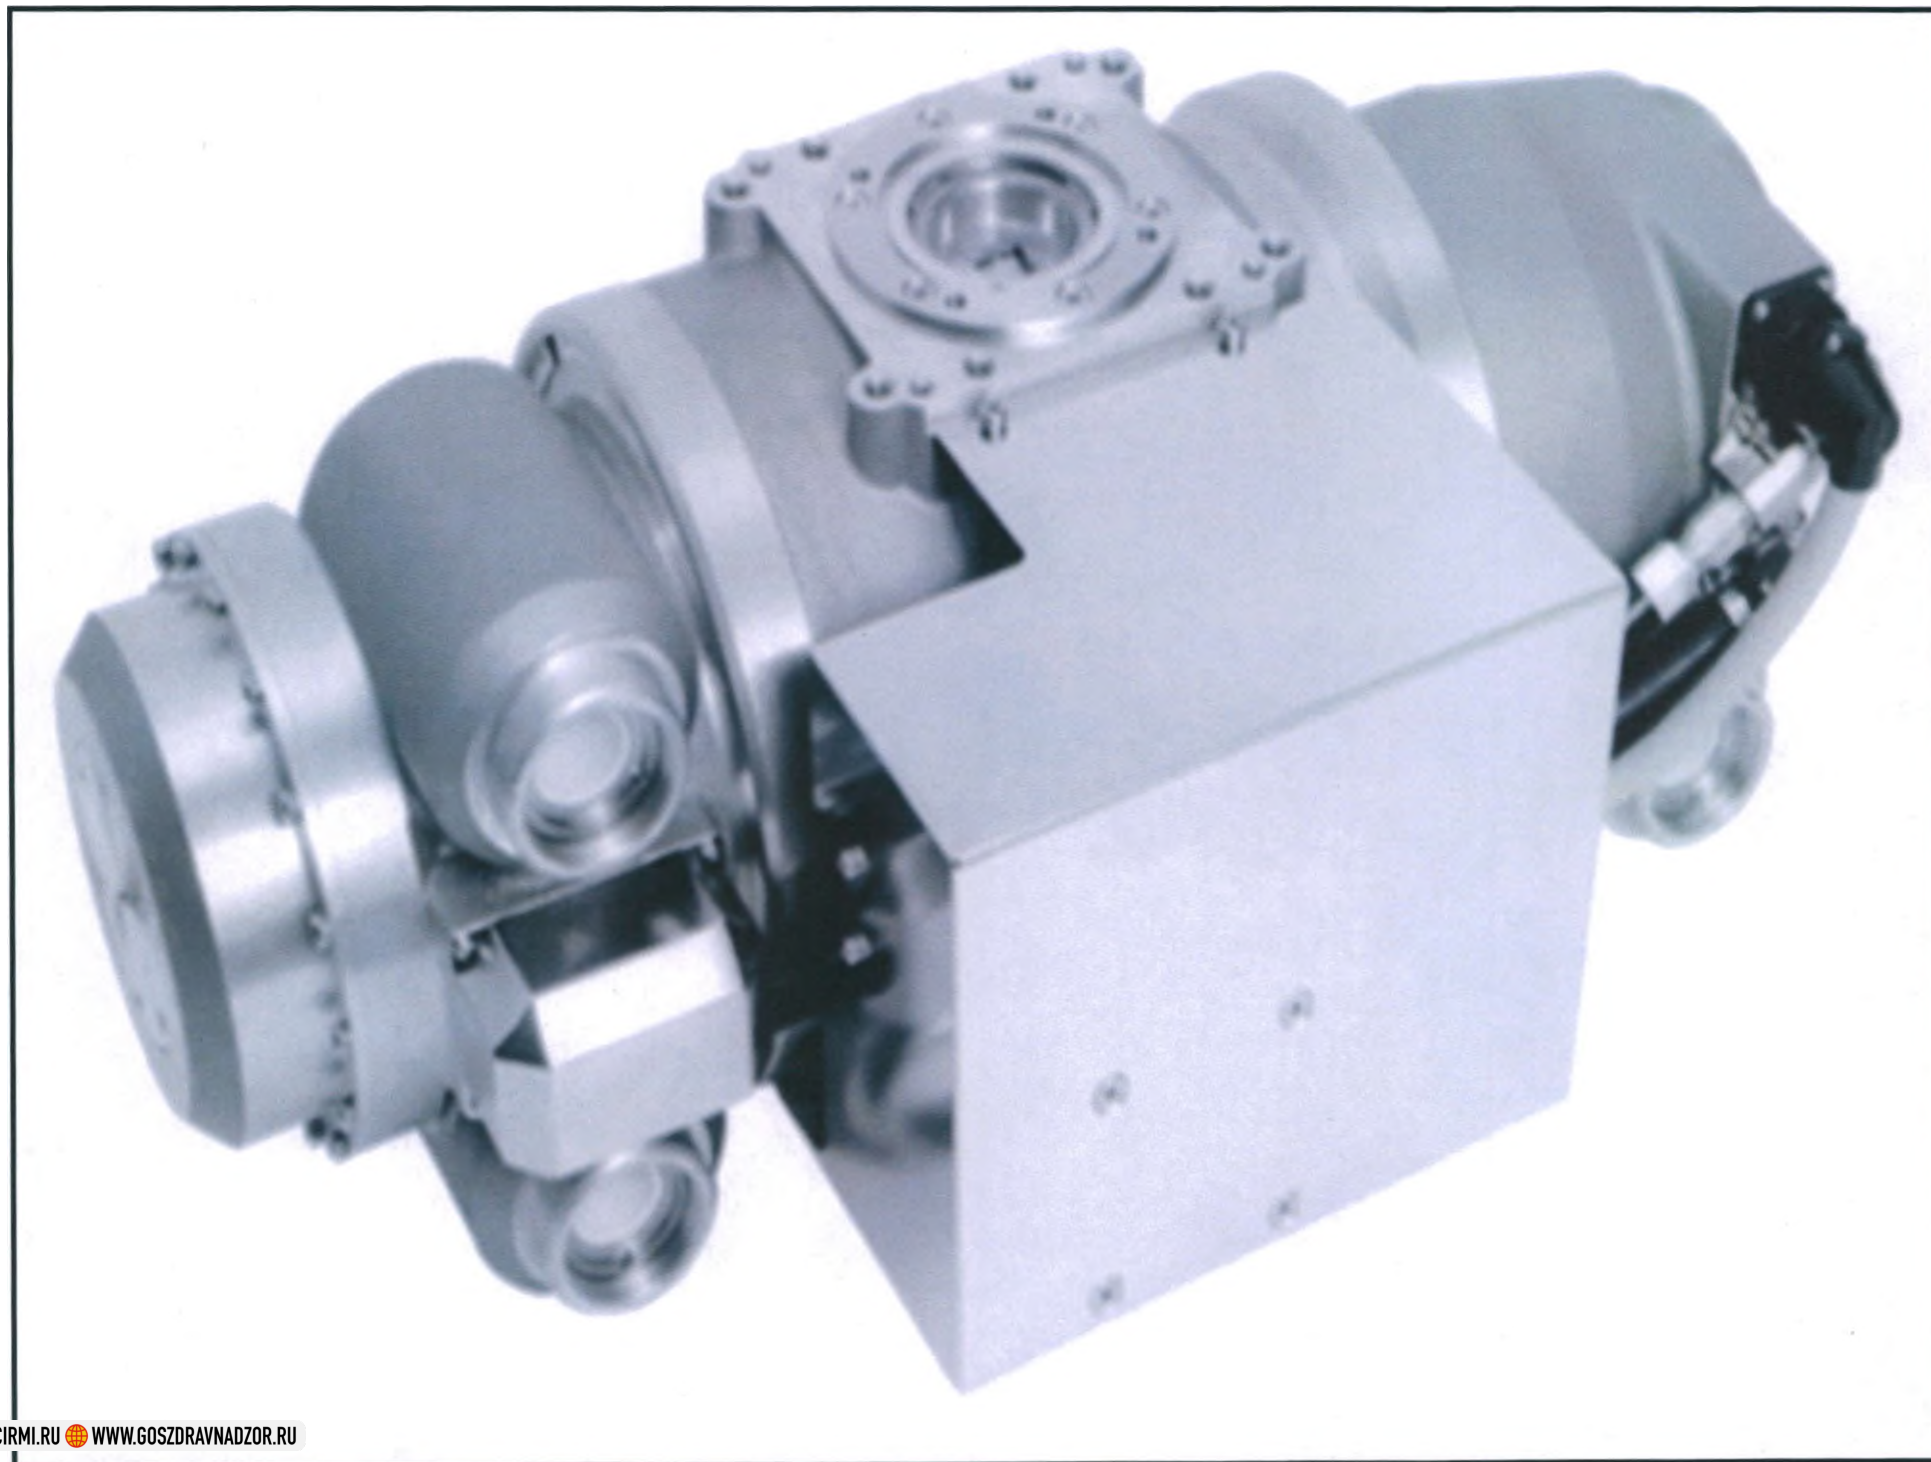

5. Скоростное пусковое устройство с вращающимся анодом (производитель Canon electron tubes & devices, Япония) - 2 шт.

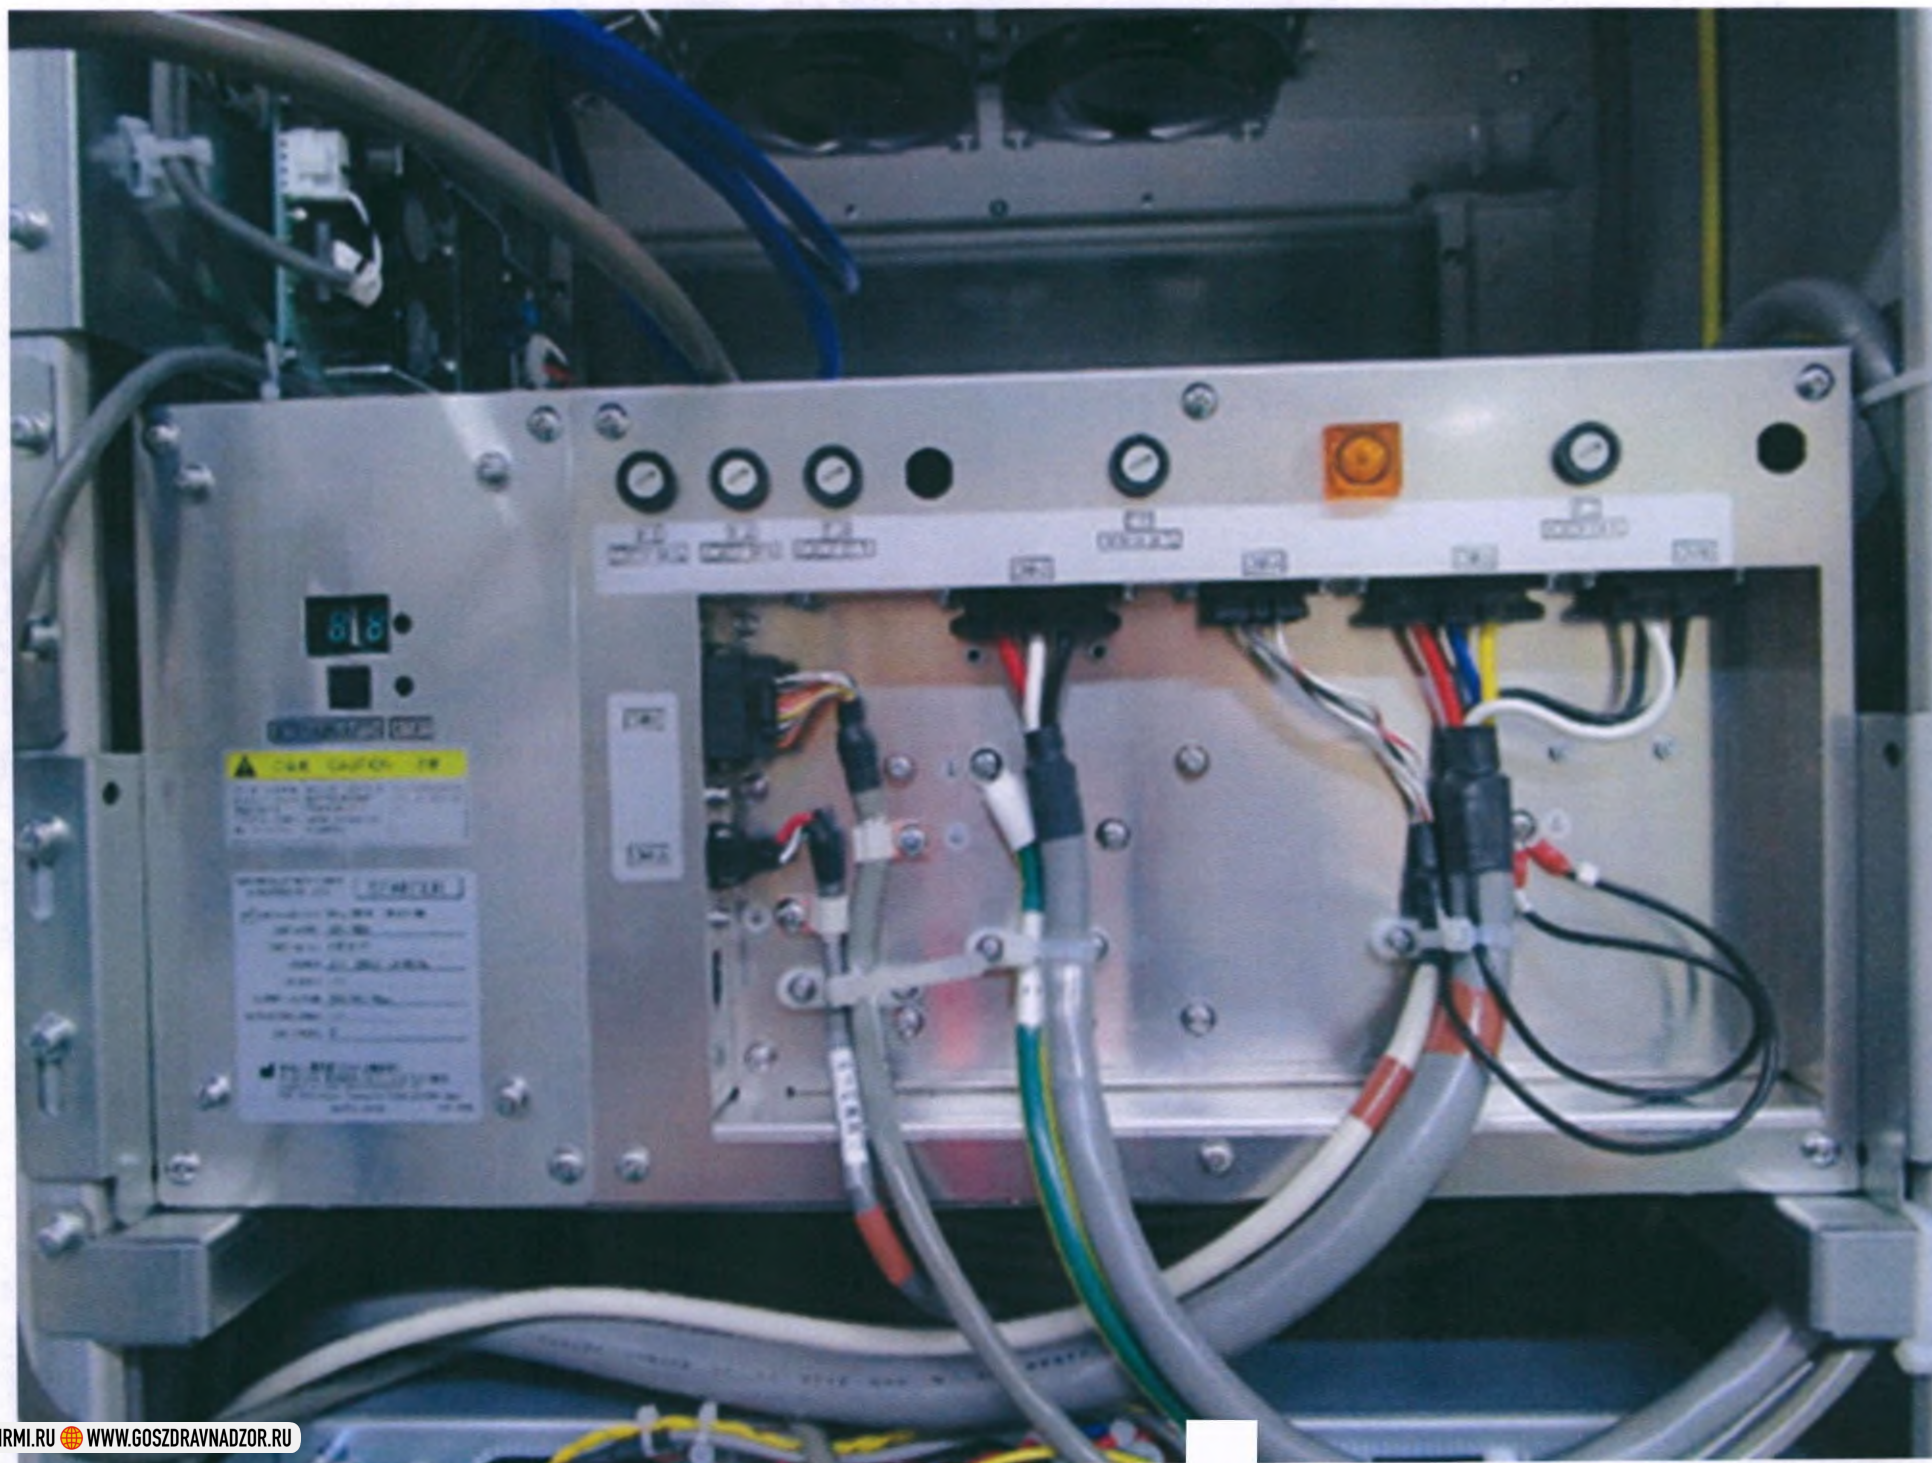


6. Комплект кабелей для рентгеновской трубки - 2 комплекта.

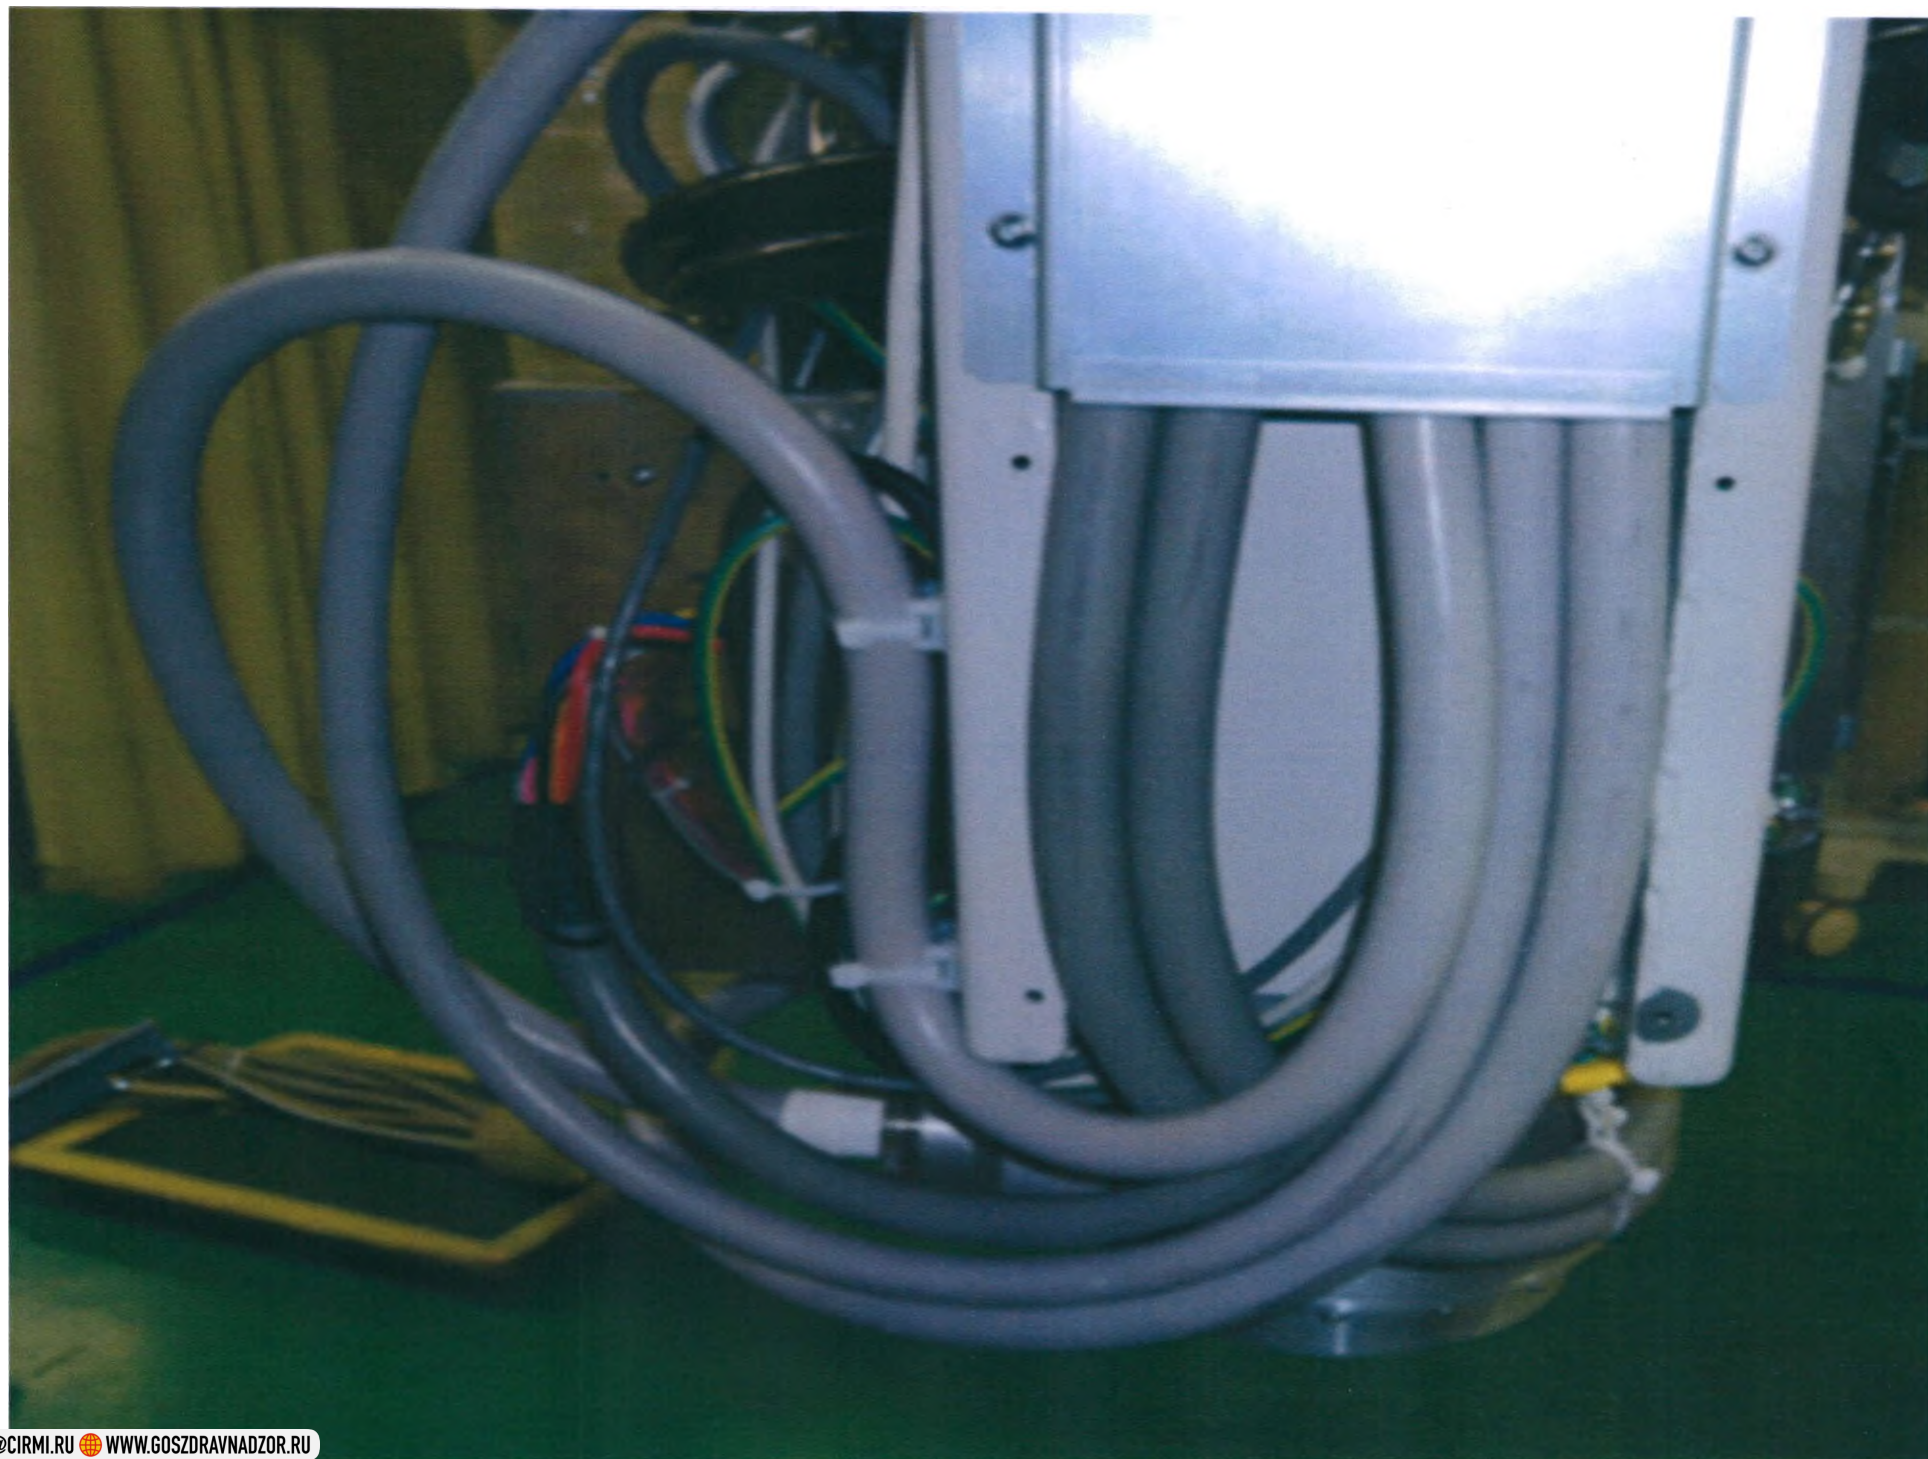

7. Теплообменник с водяным охлаждением (производитель Canon electron tubes & devices, Япония) - 2 шт.



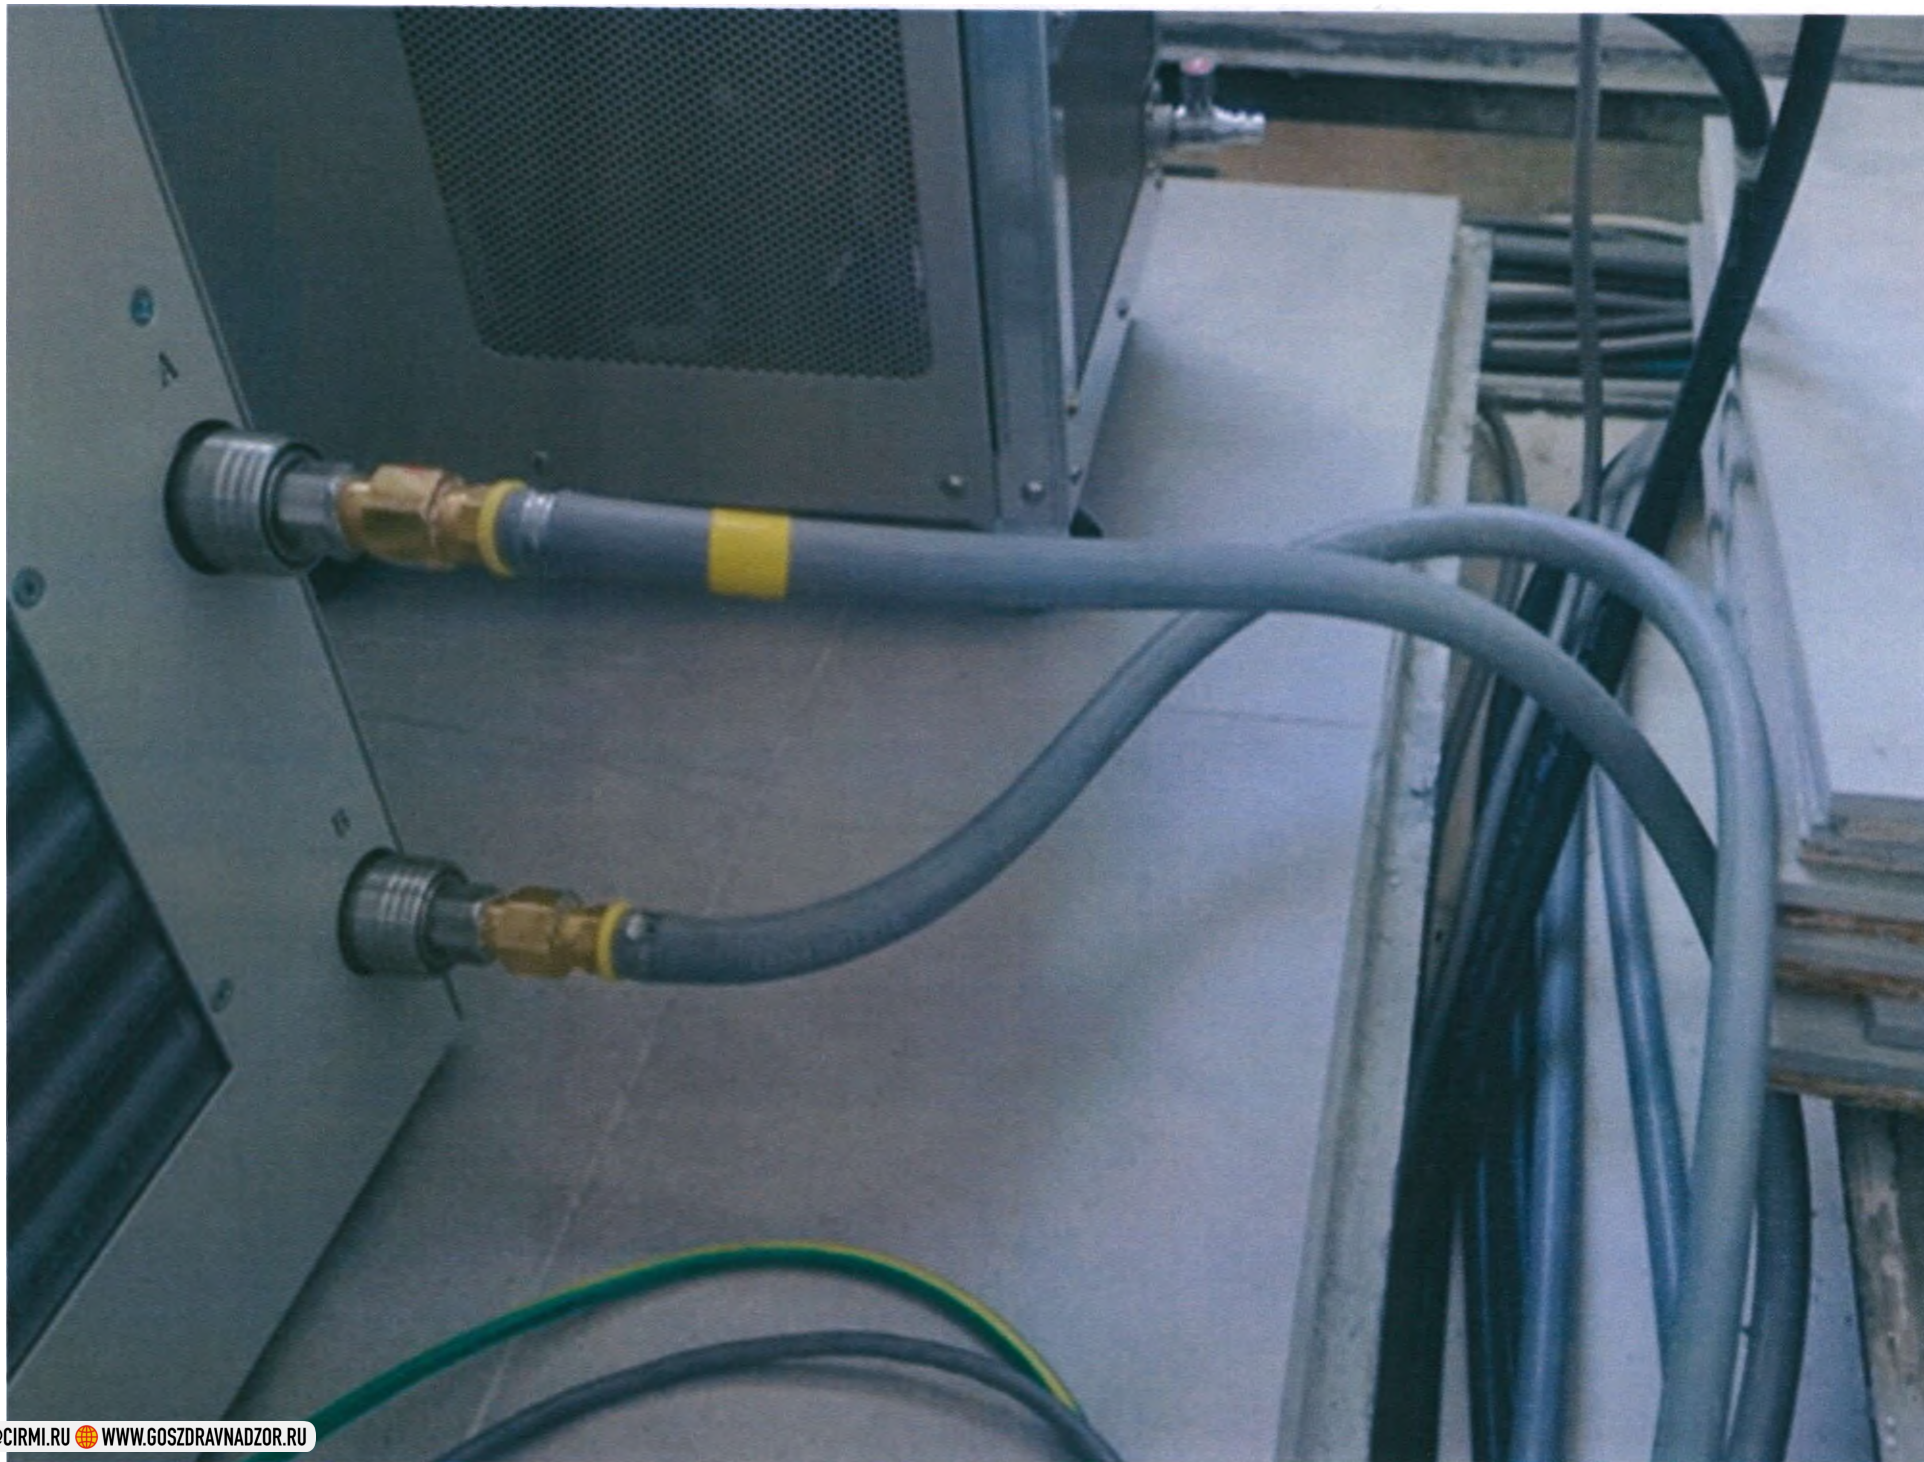



10. Рентгеновский плоскопанельный детектор с водяным охлаждением, 8-дюймовый FPD - 2 шт.



Блок водяного охлаждения




Основной блок 8-дюймового FPD




Командный процессор

11. Боковая консоль стола (для двухпроекционной системы).




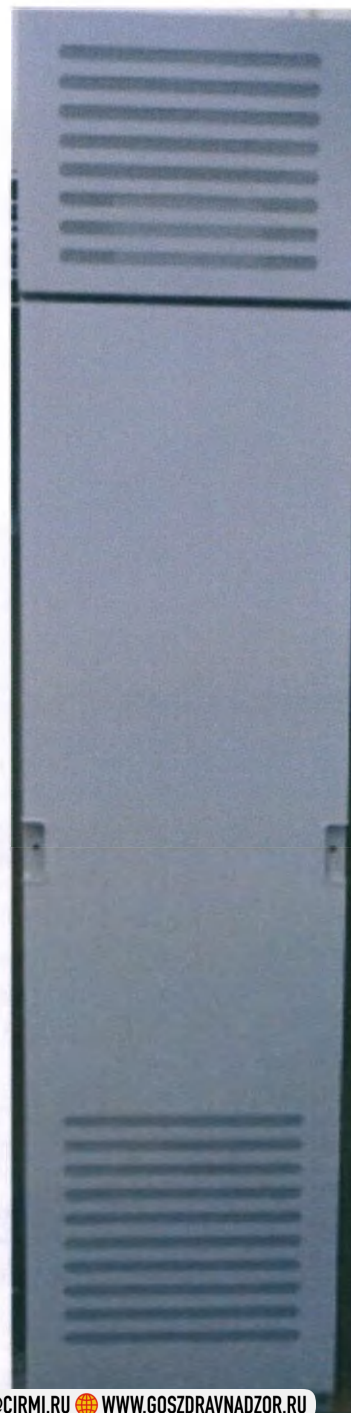


Установлены внутри
шкафа управления
CAS-880A

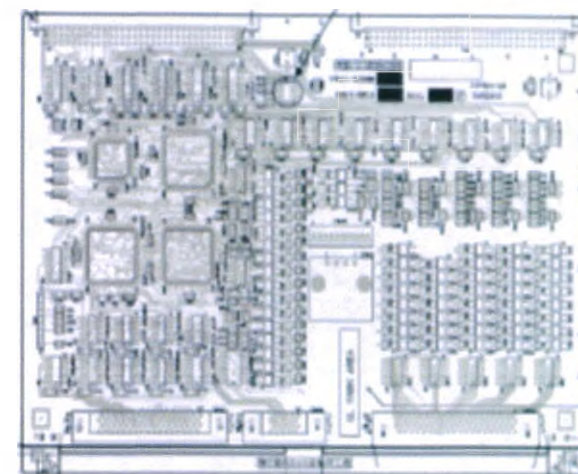

Электронная плата Hyper IO pcb

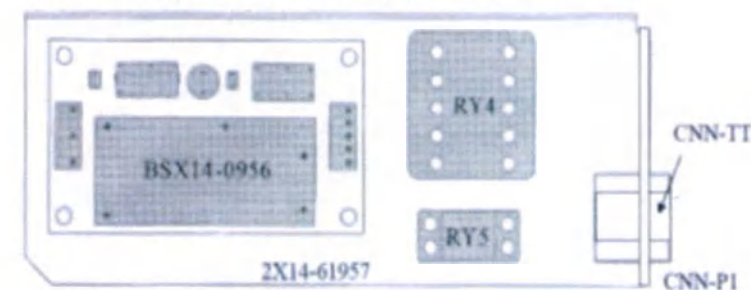

Интерфейсный блок

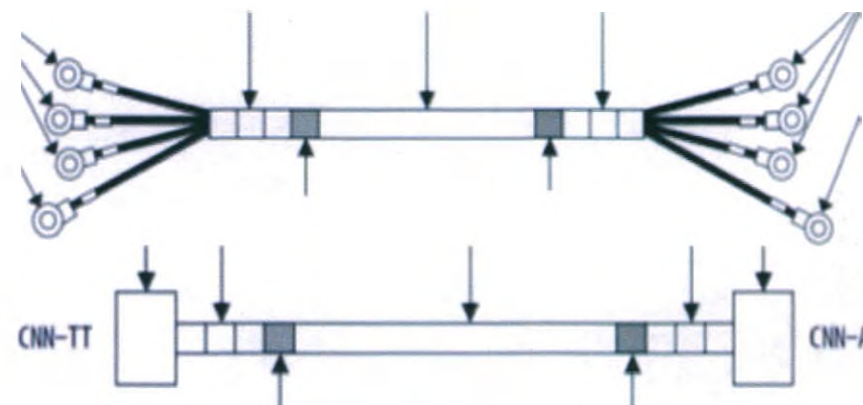


Интерфейсные кабели

13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: - основная часть стола для катетеризации;




13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: - стандартная накладка для деки стола;

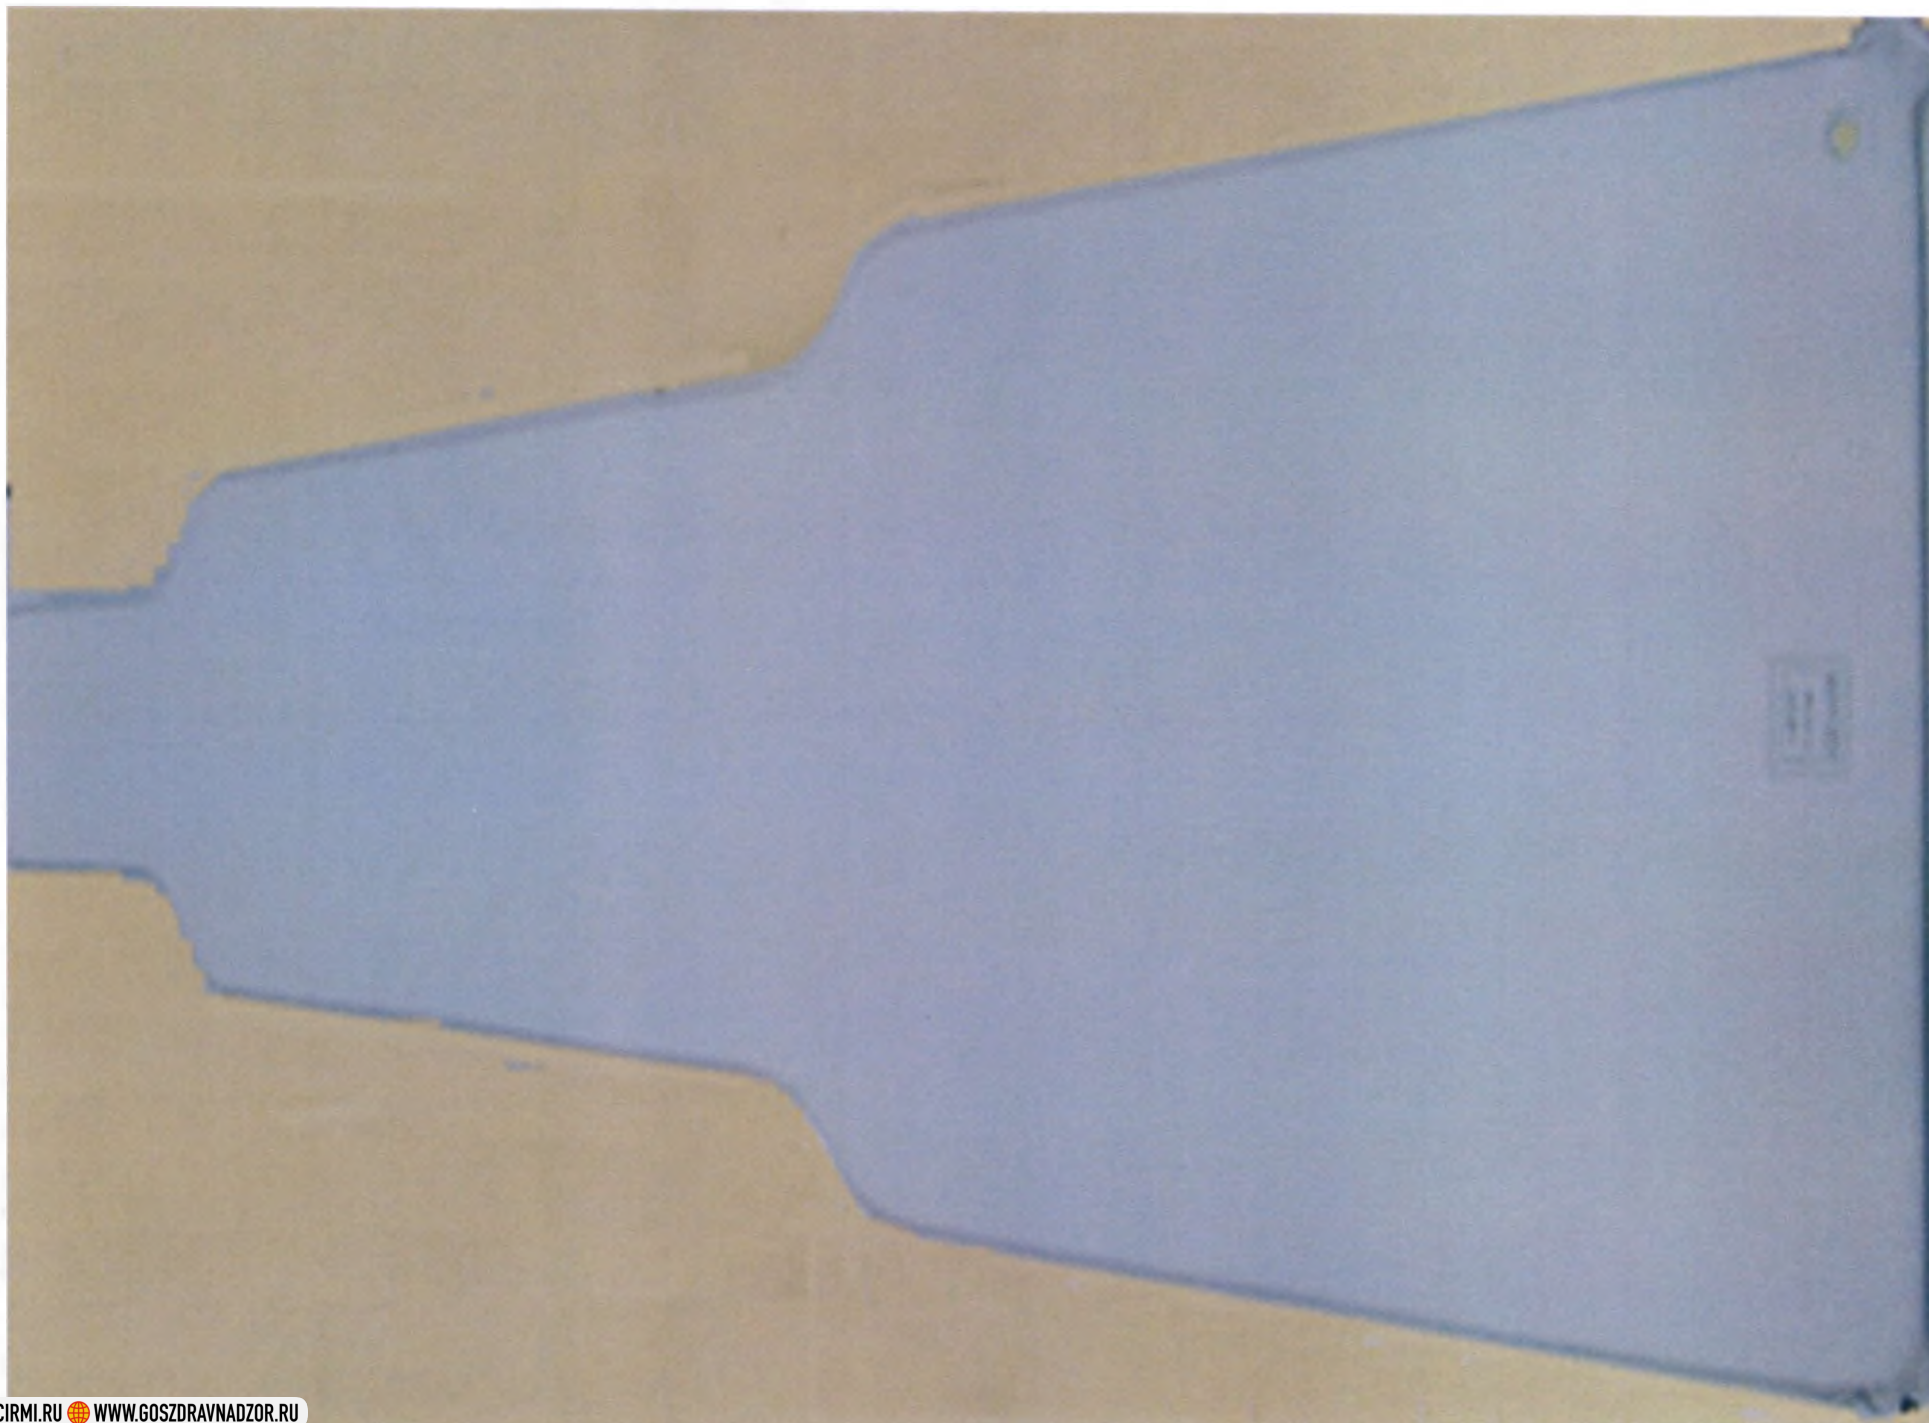



13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель CAT-850B, в составе: - опора для рук;



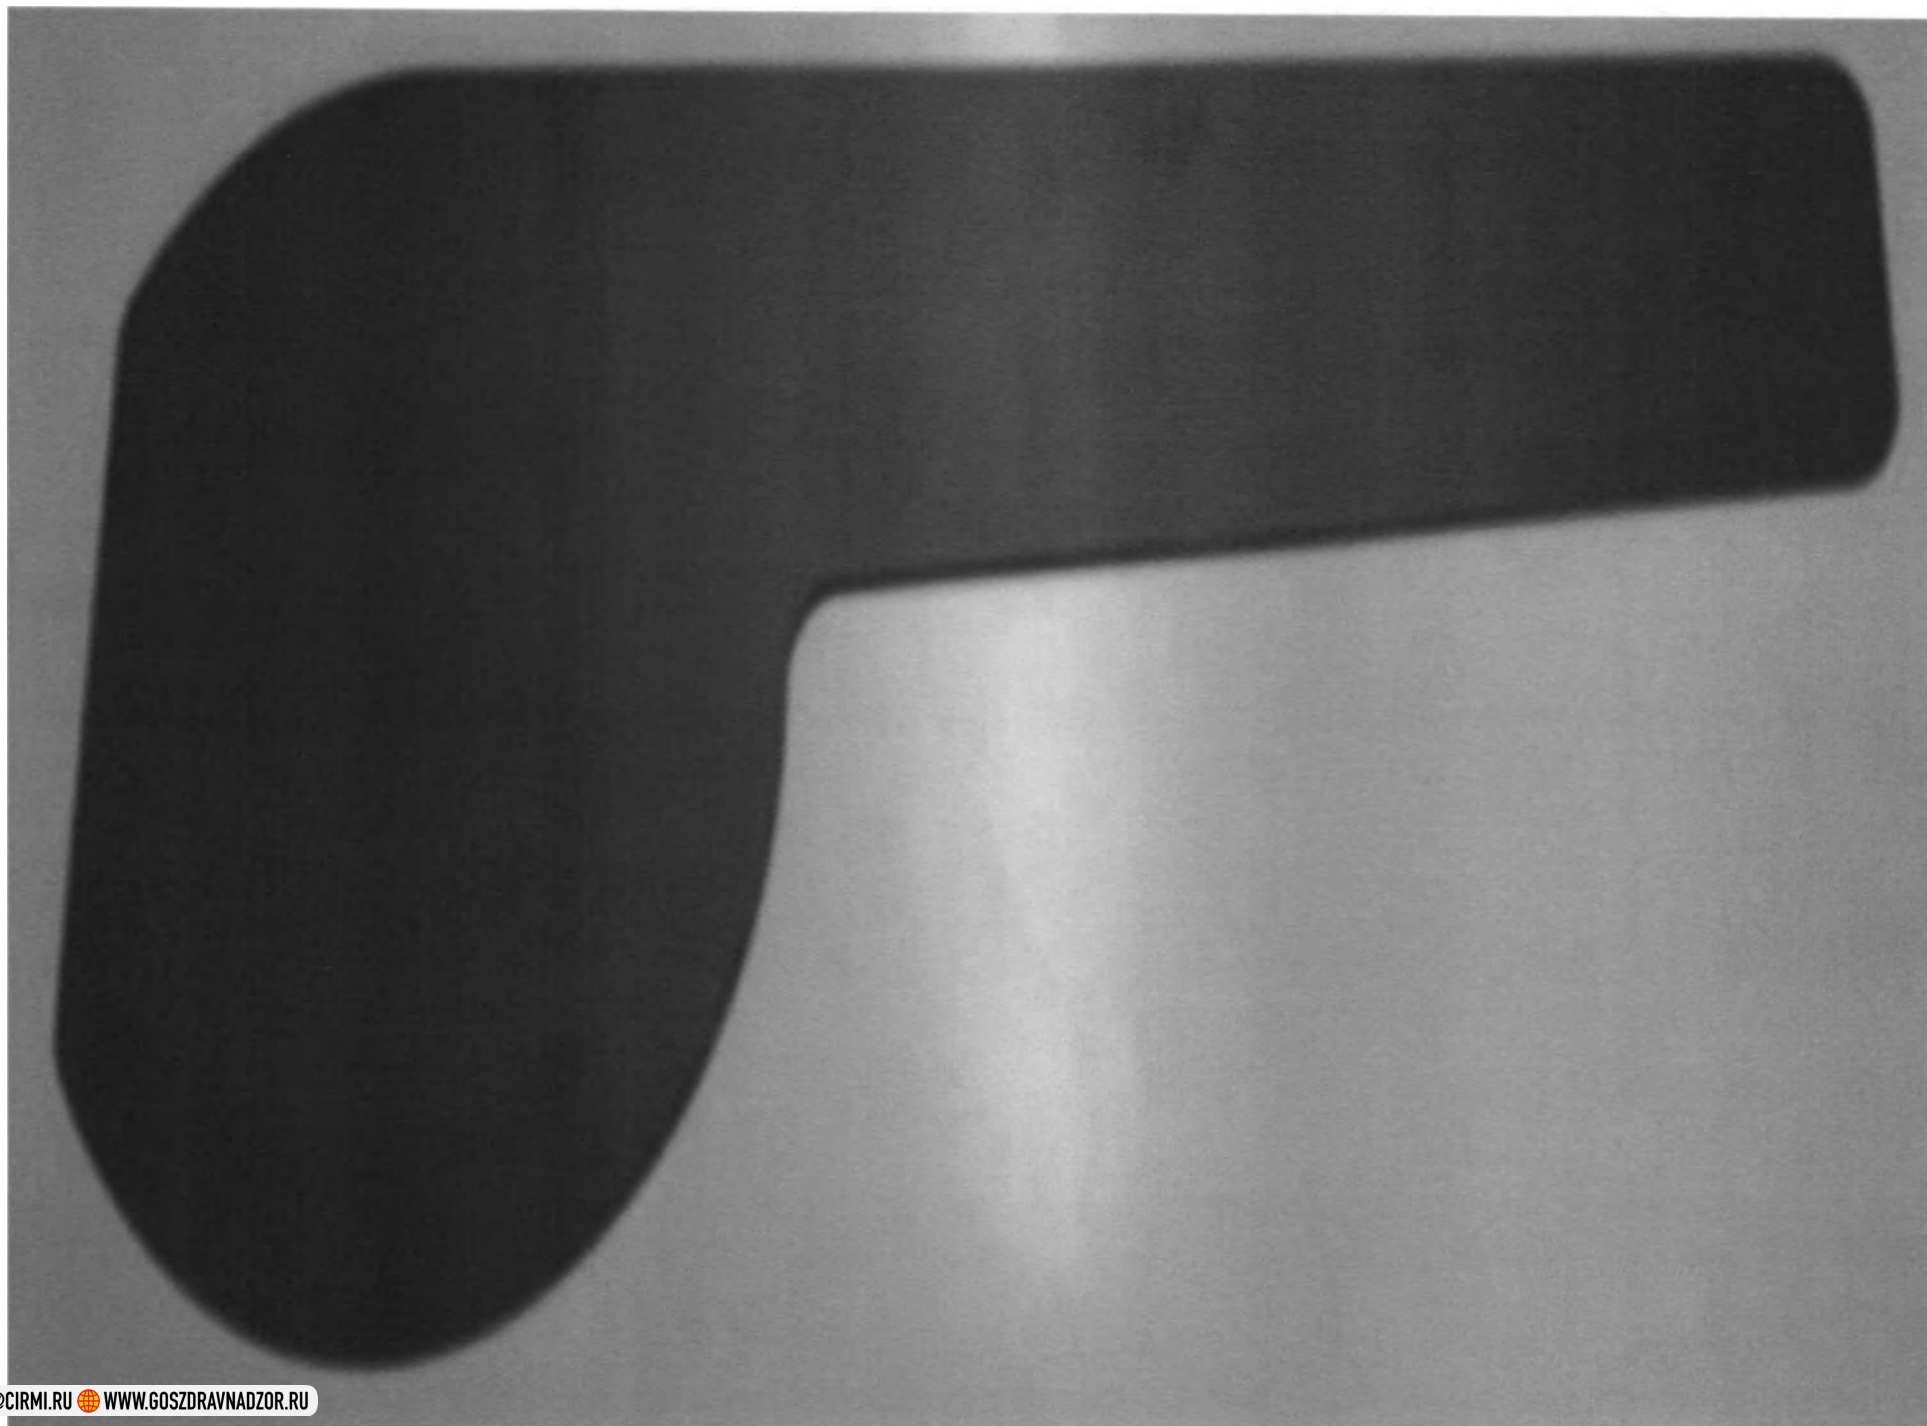

13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель CAT-880B, в составе: - основная часть стола для катетеризации;



13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - пульт управления столом;



13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - стойка для капельной инфузии;



13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - стандартная накладка для деки стола;




13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - ремень для иммобилизации пациента - не более 2-х штук.

304



14. Ножной переключатель (в кабинете сканирования) для двухпроекционной системы.



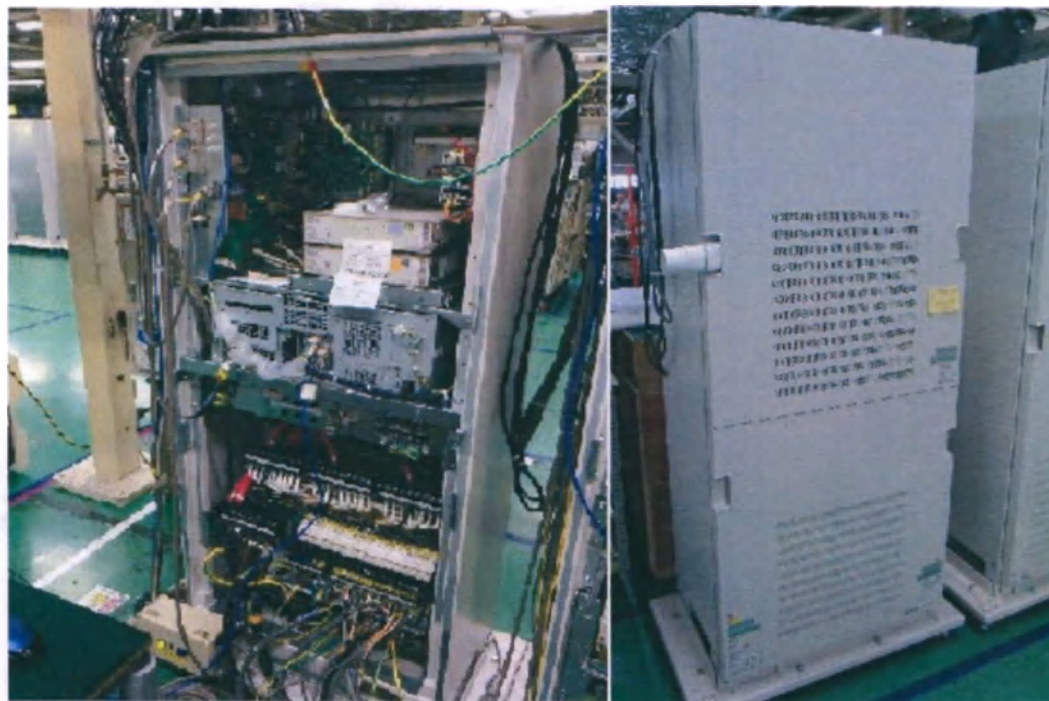

Системный шкаф



Компьютер
консоли системы



Блок управления



Программное обеспечение
основное

16. Консоль системы, в составе: - комплект клавиатуры;



16. Консоль системы, в составе: - комплект клавиатуры;



16. Консоль системы, в составе: - монитор системы; - блок включения электропитания.




17. Ножной переключатель для рентгеноскопии в кабинете управления (для двухпроекционной системы).









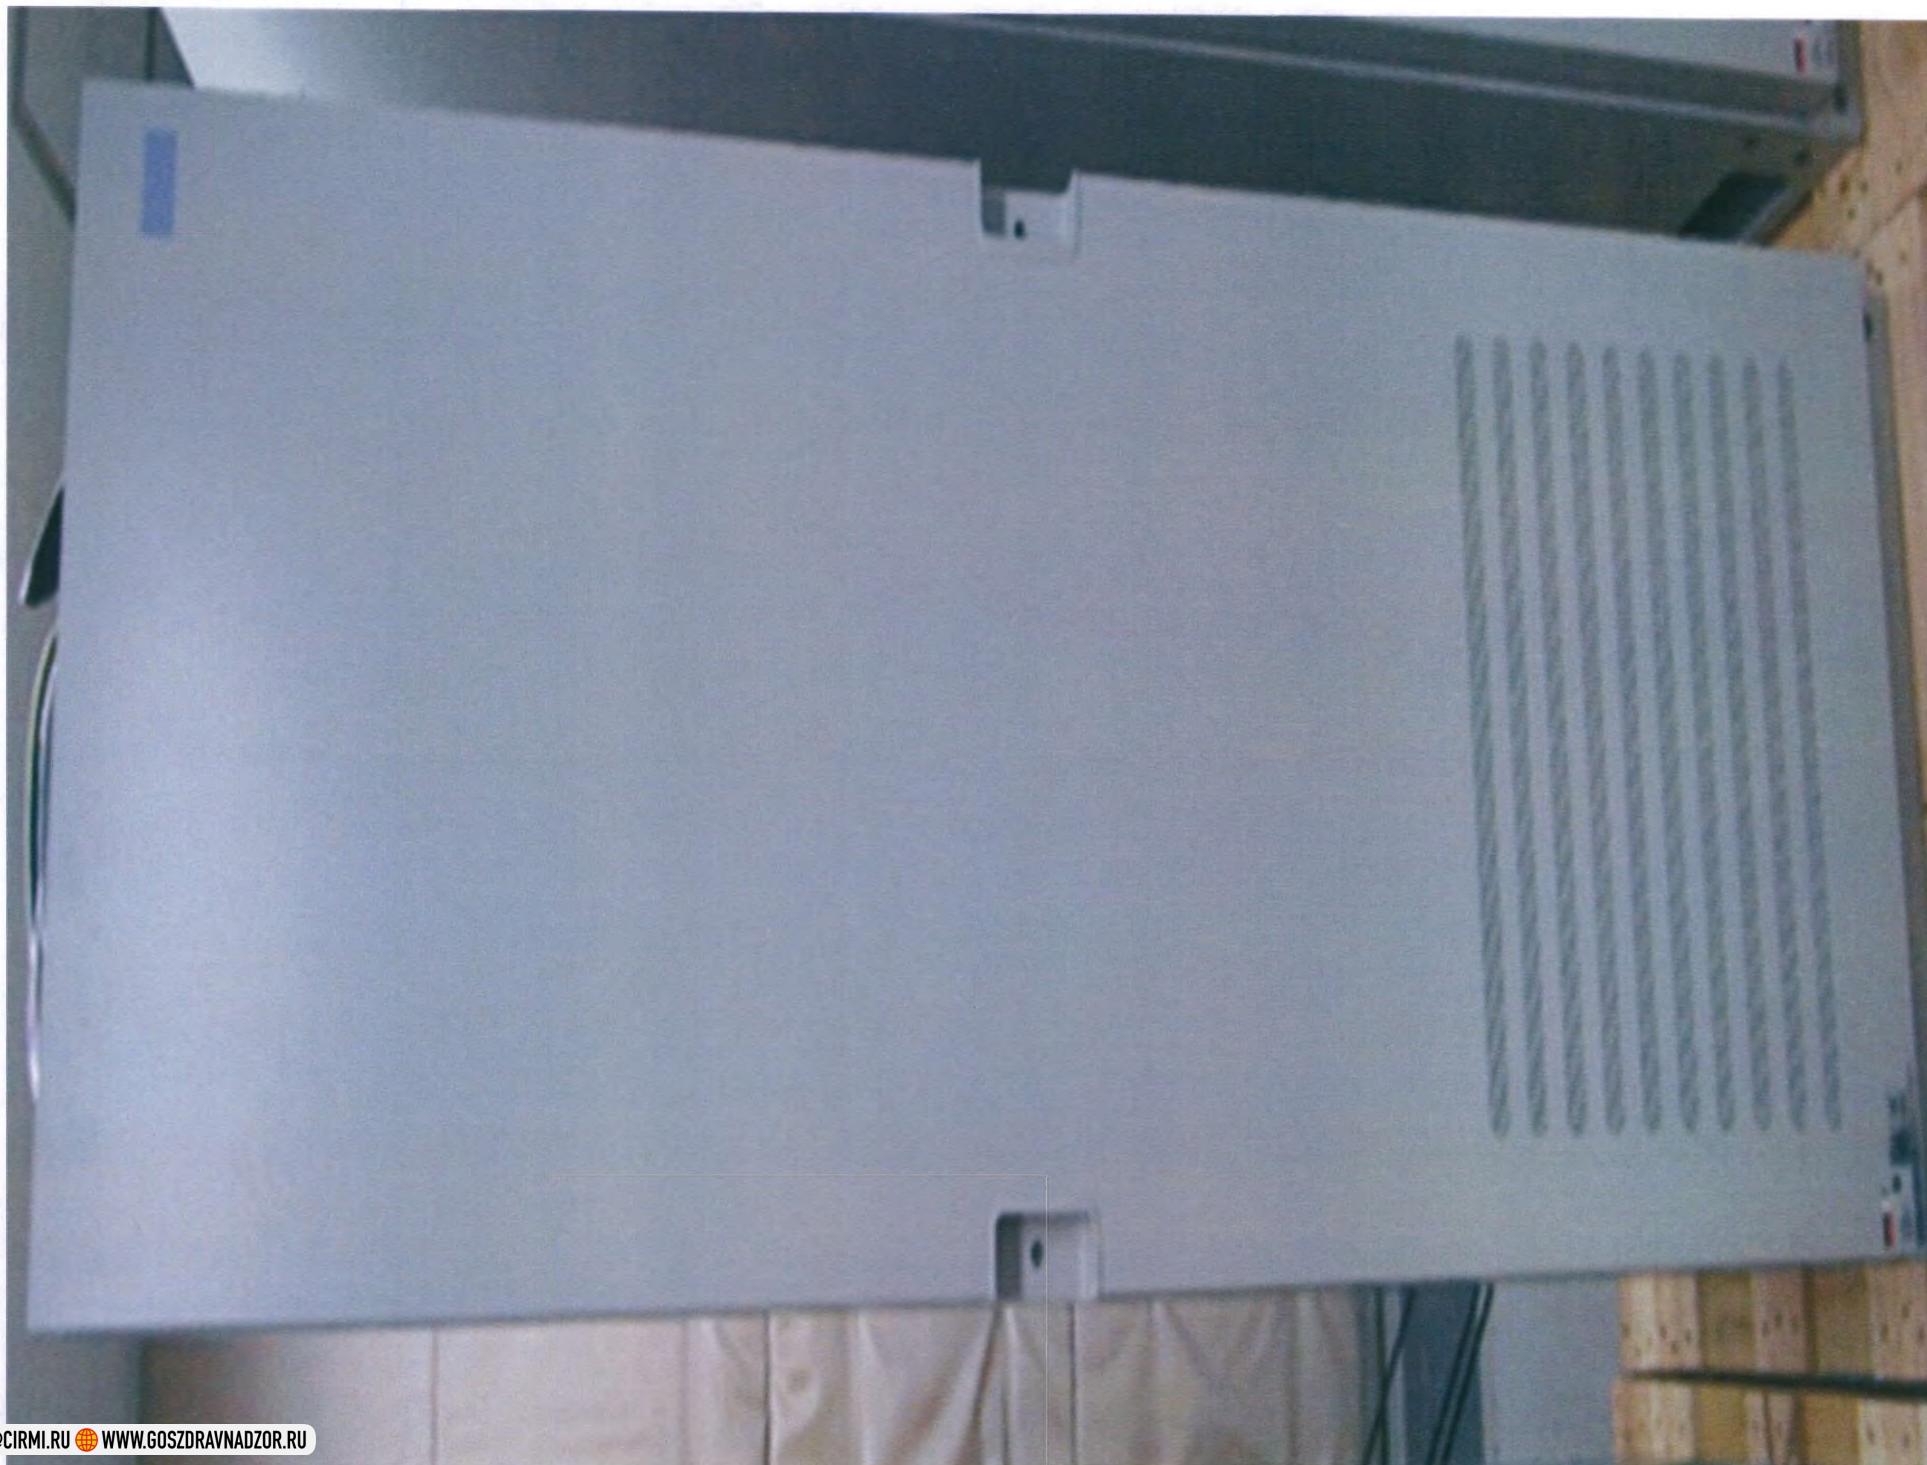



21. Подвесное устройство для мониторов.

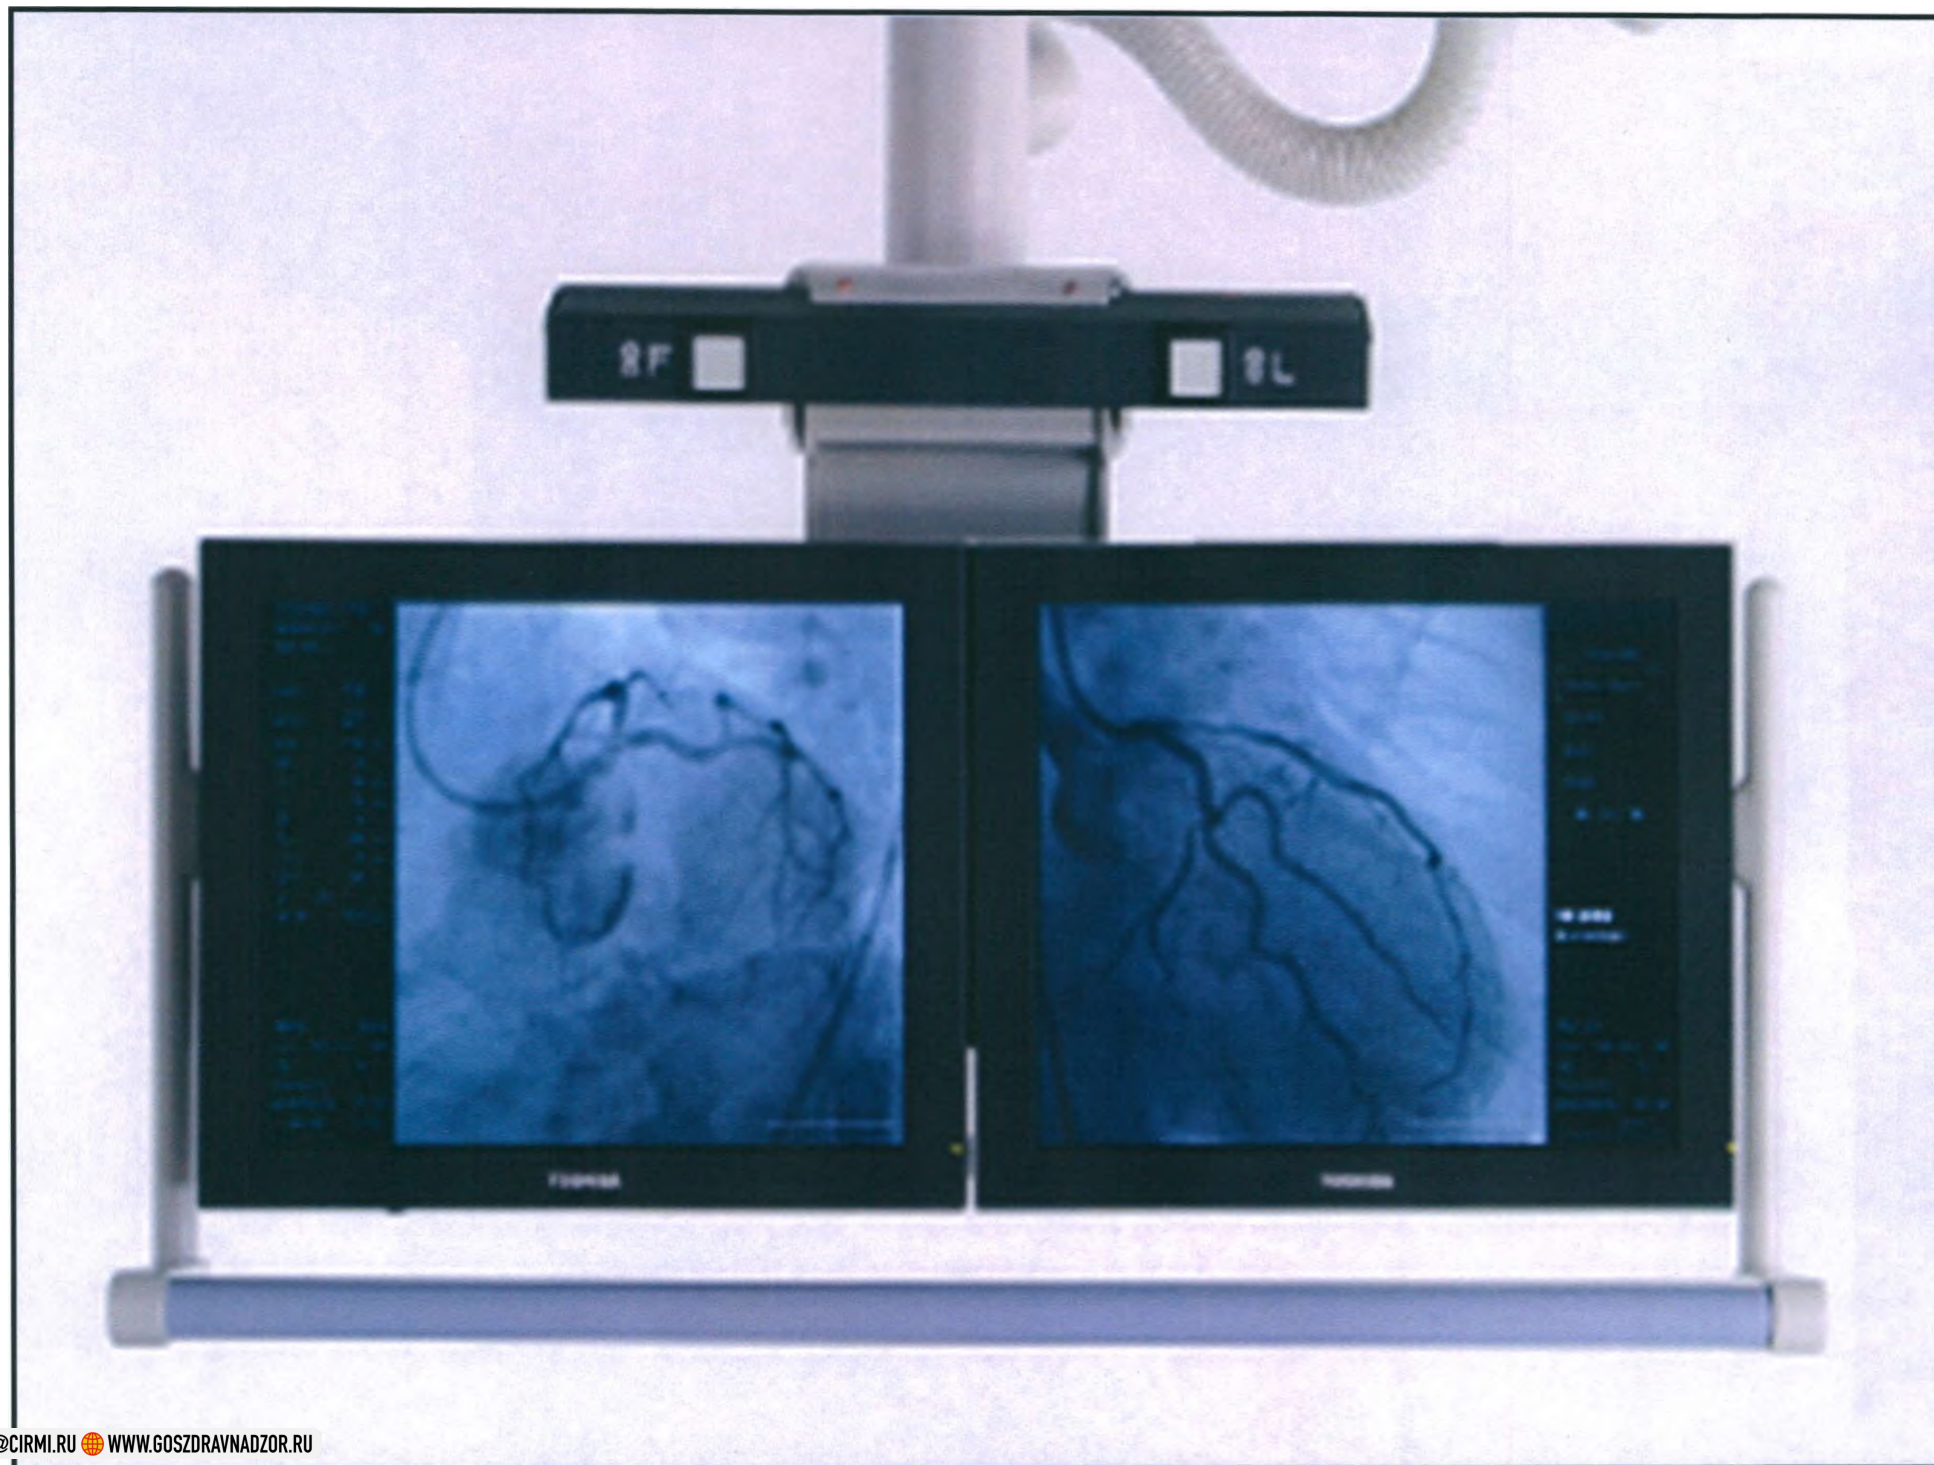


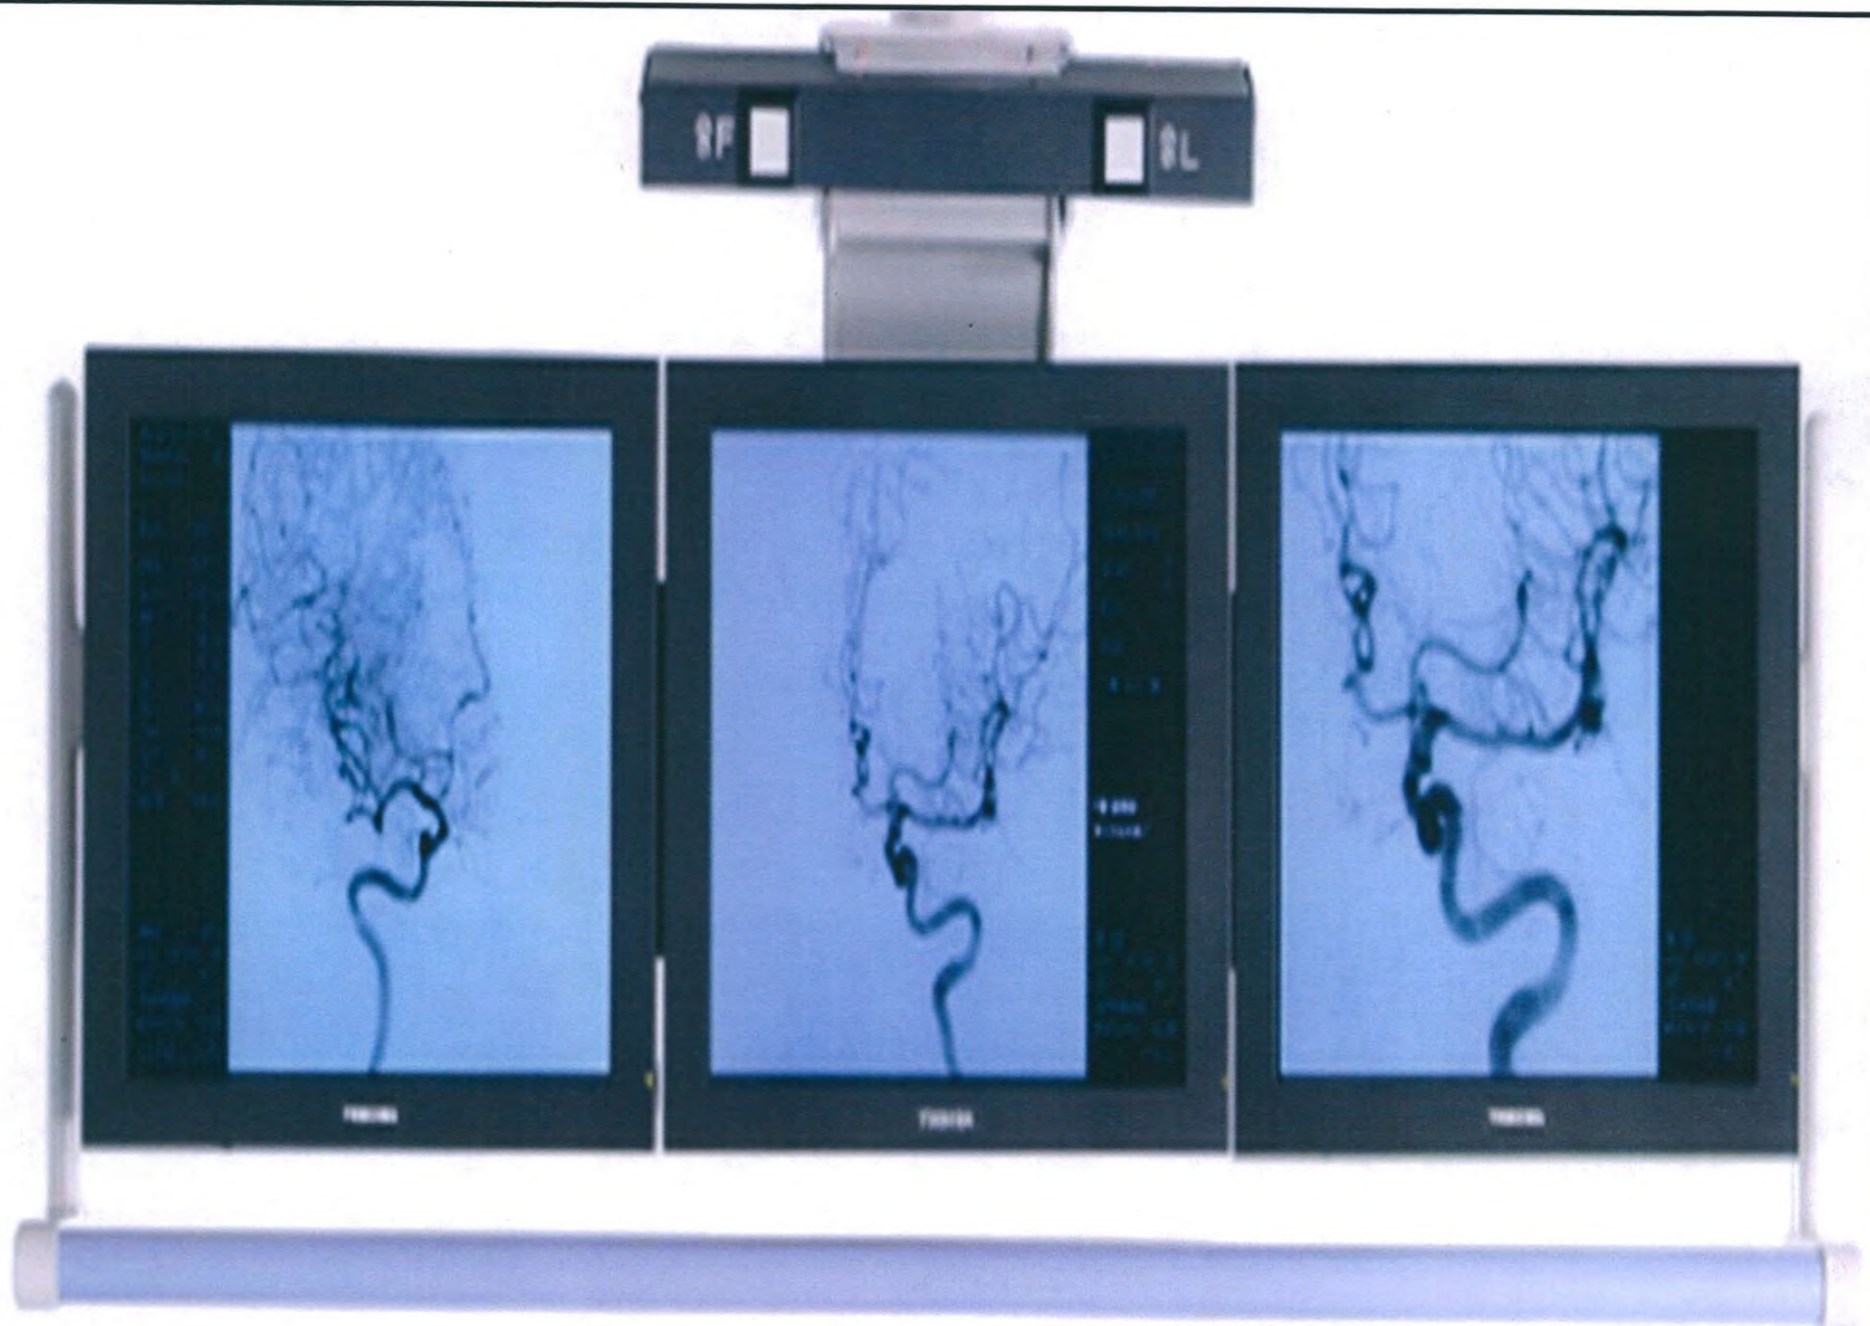


21. Подвесное устройство для мониторов.

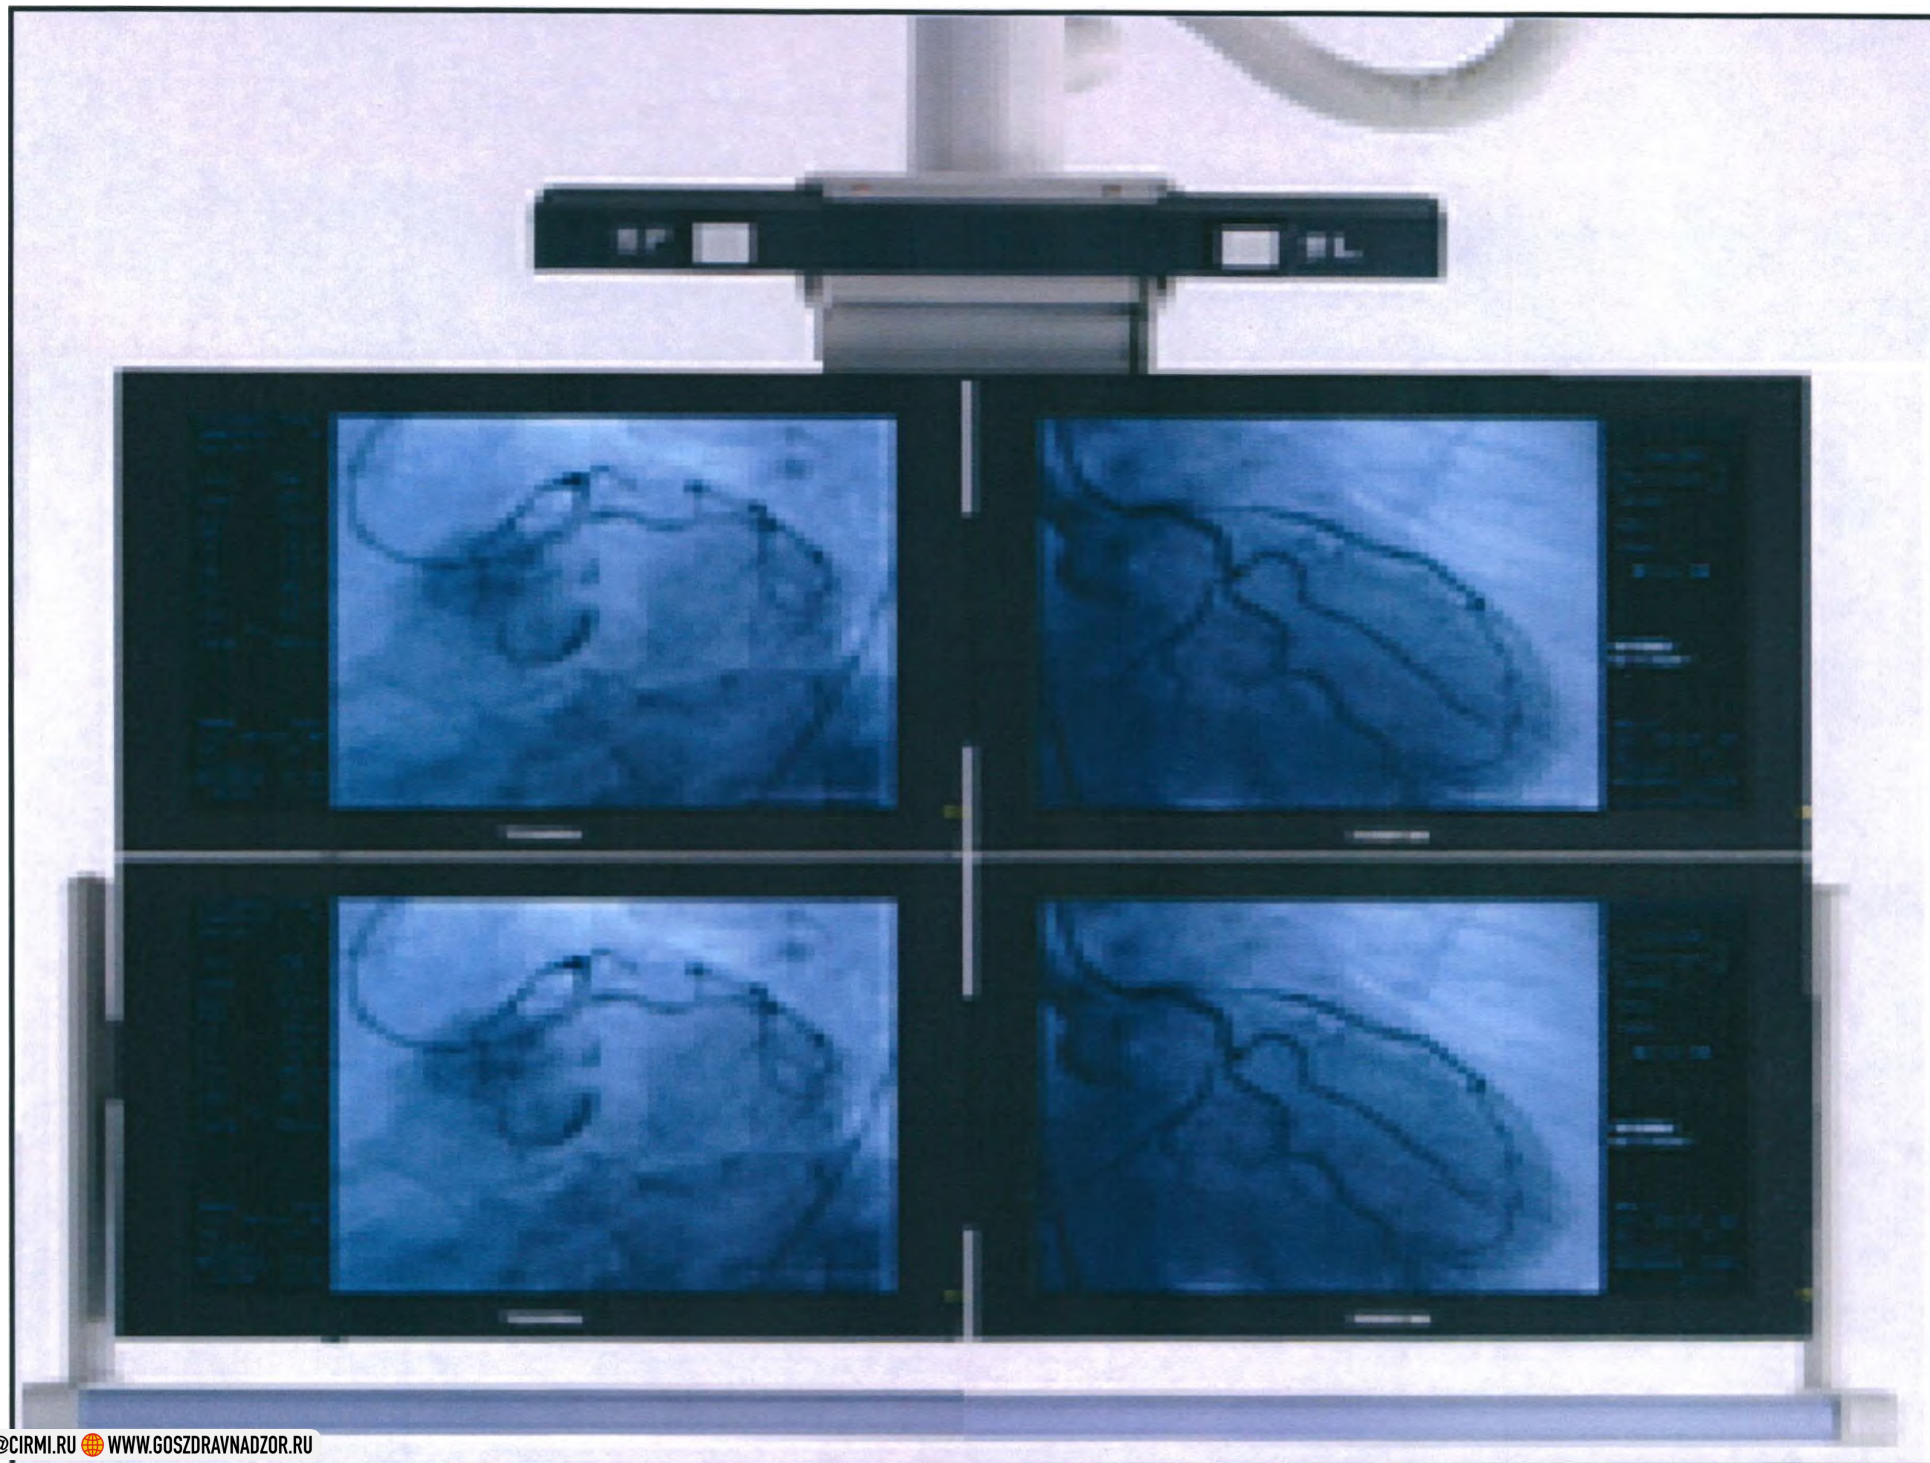

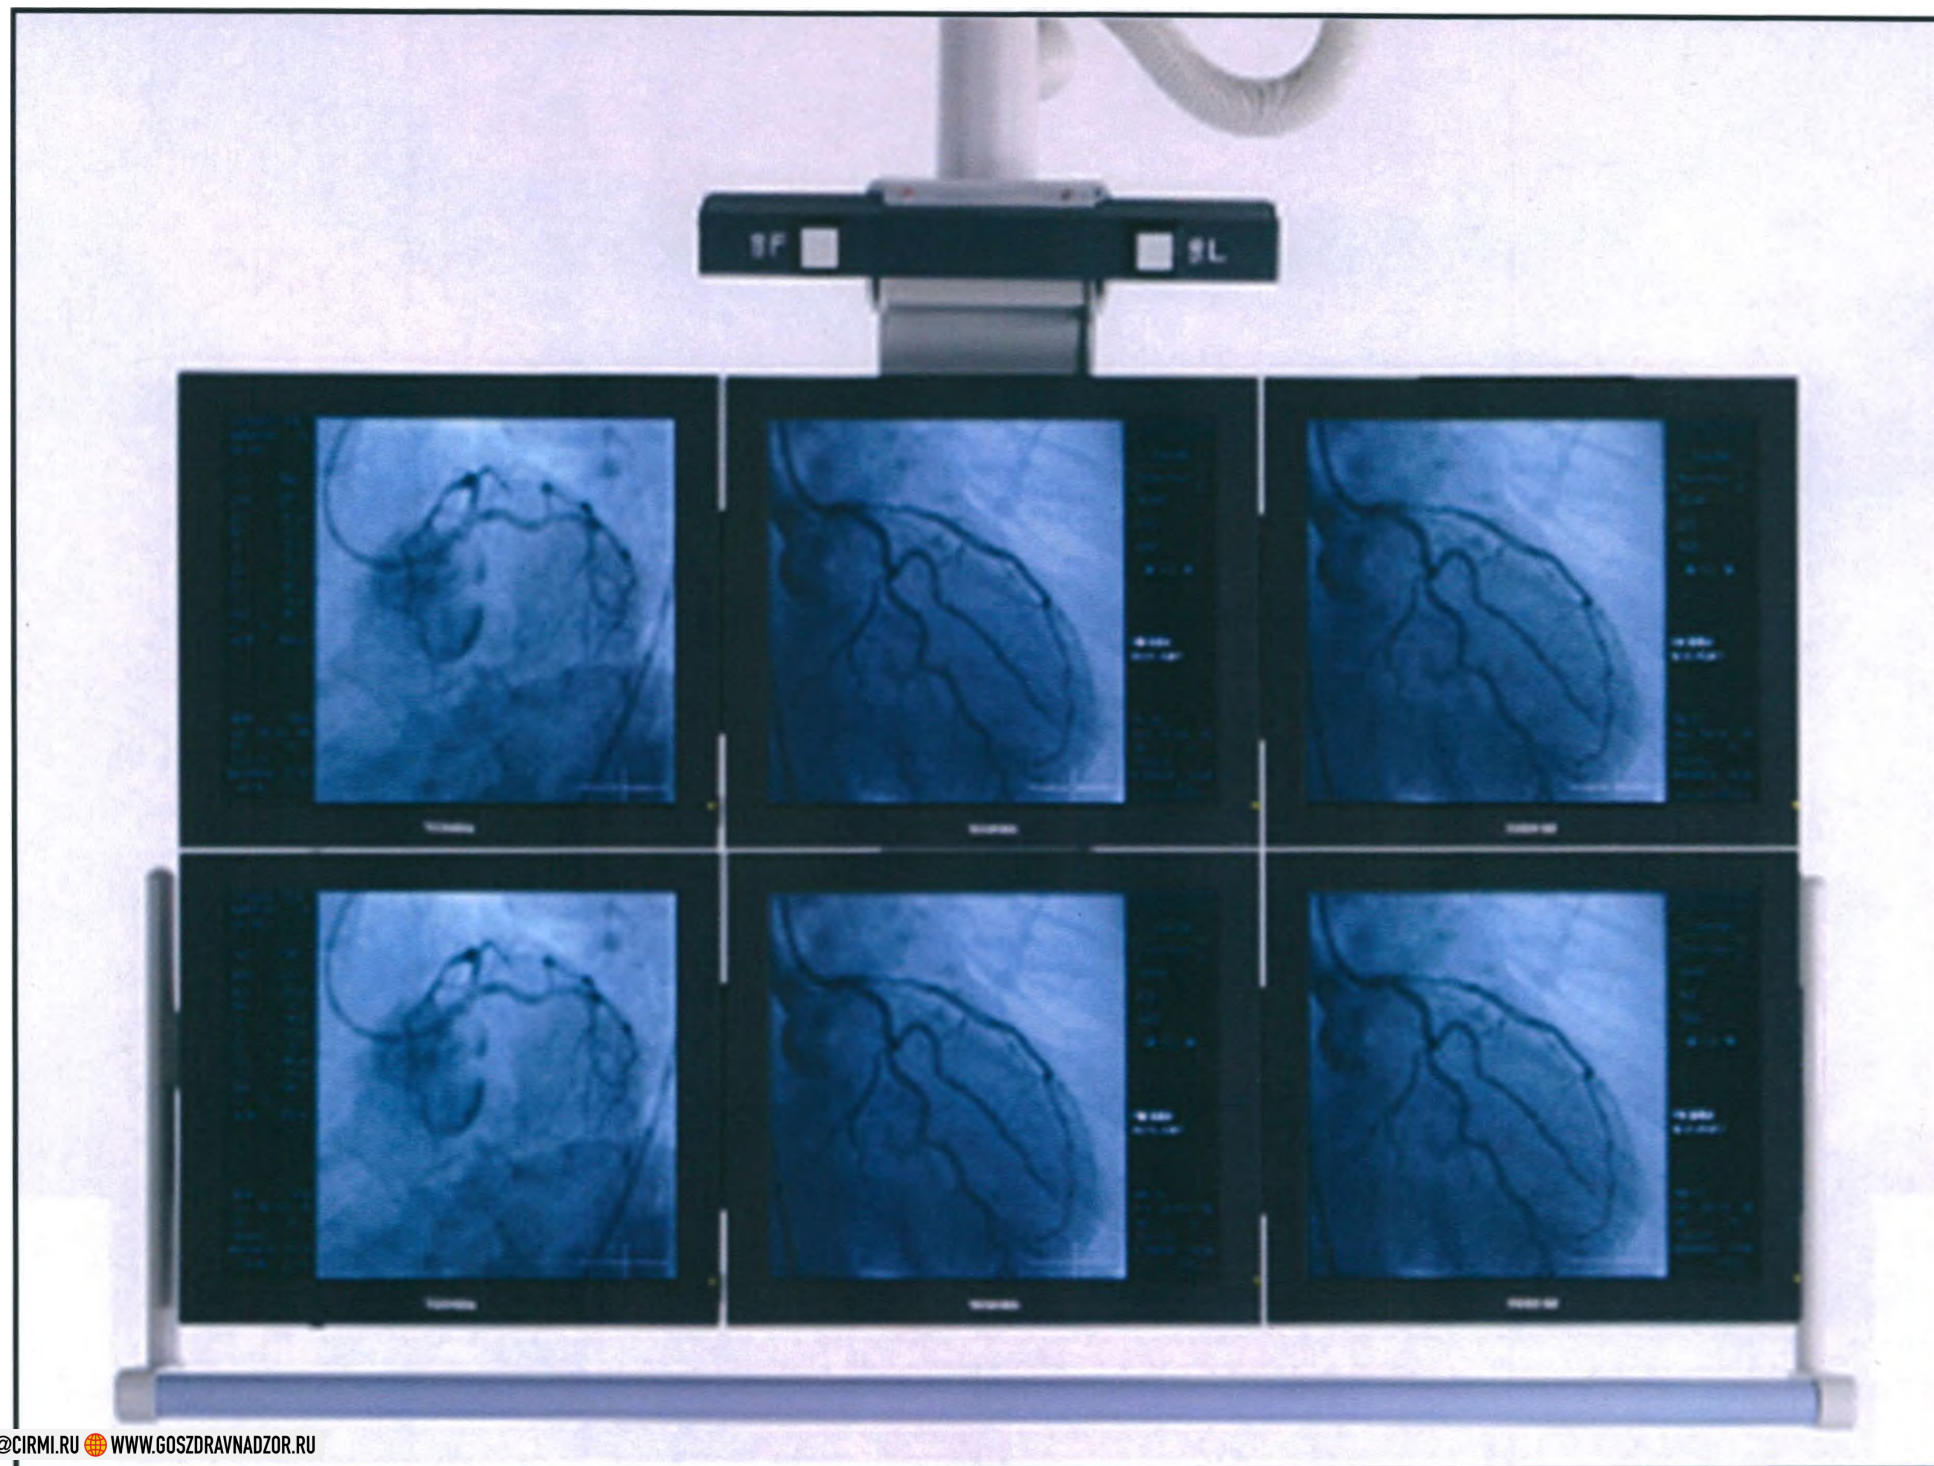


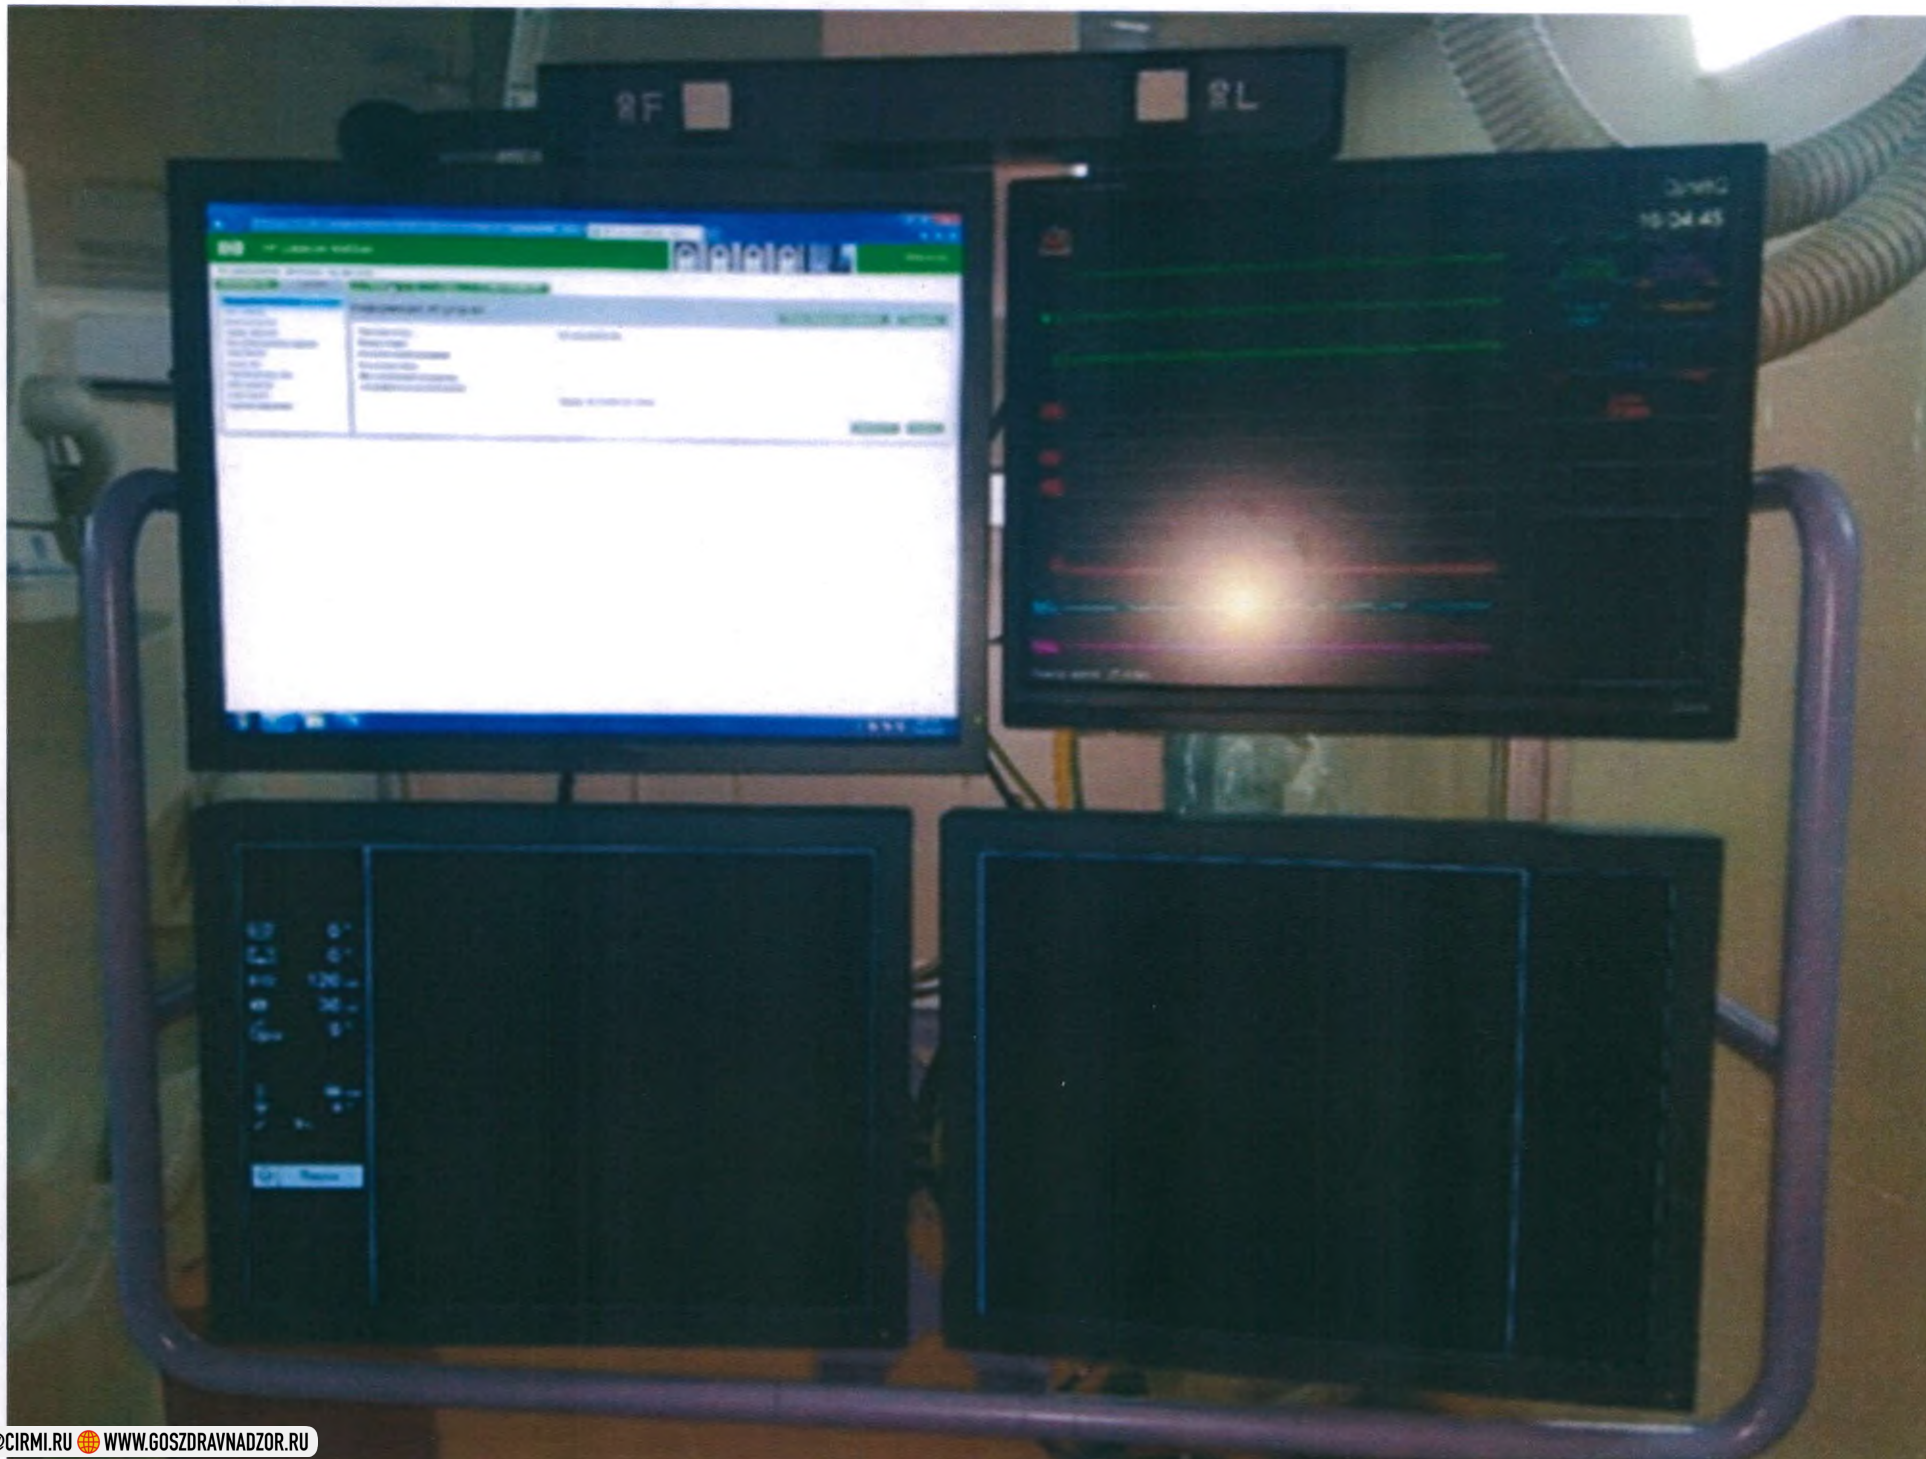

21. Подвесное устройство для мониторов.


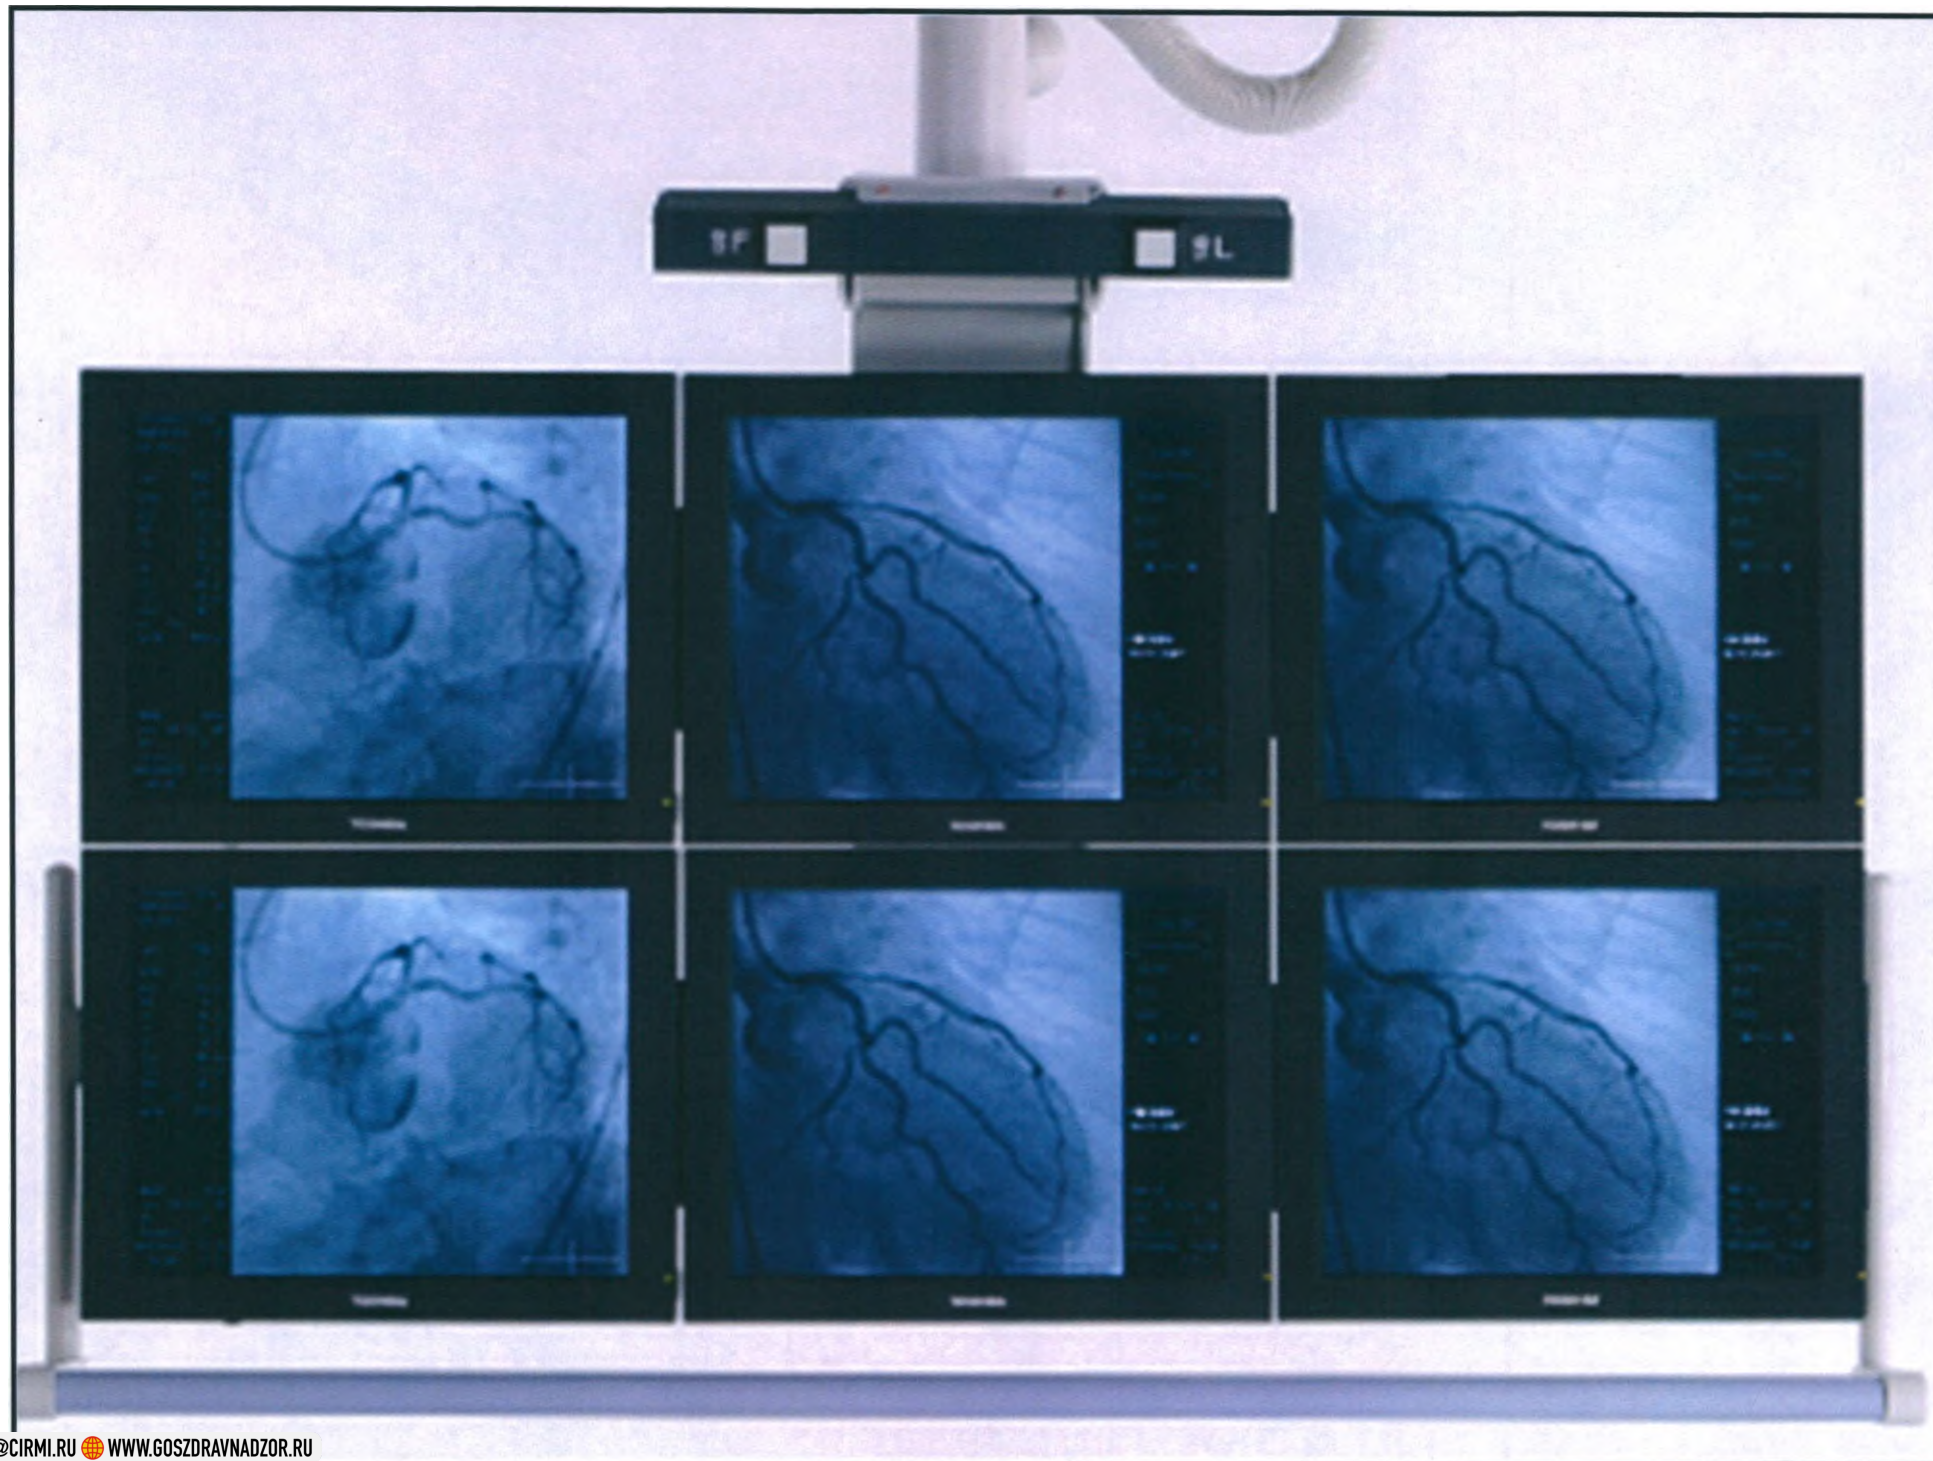


21. Подвесное устройство для мониторов.

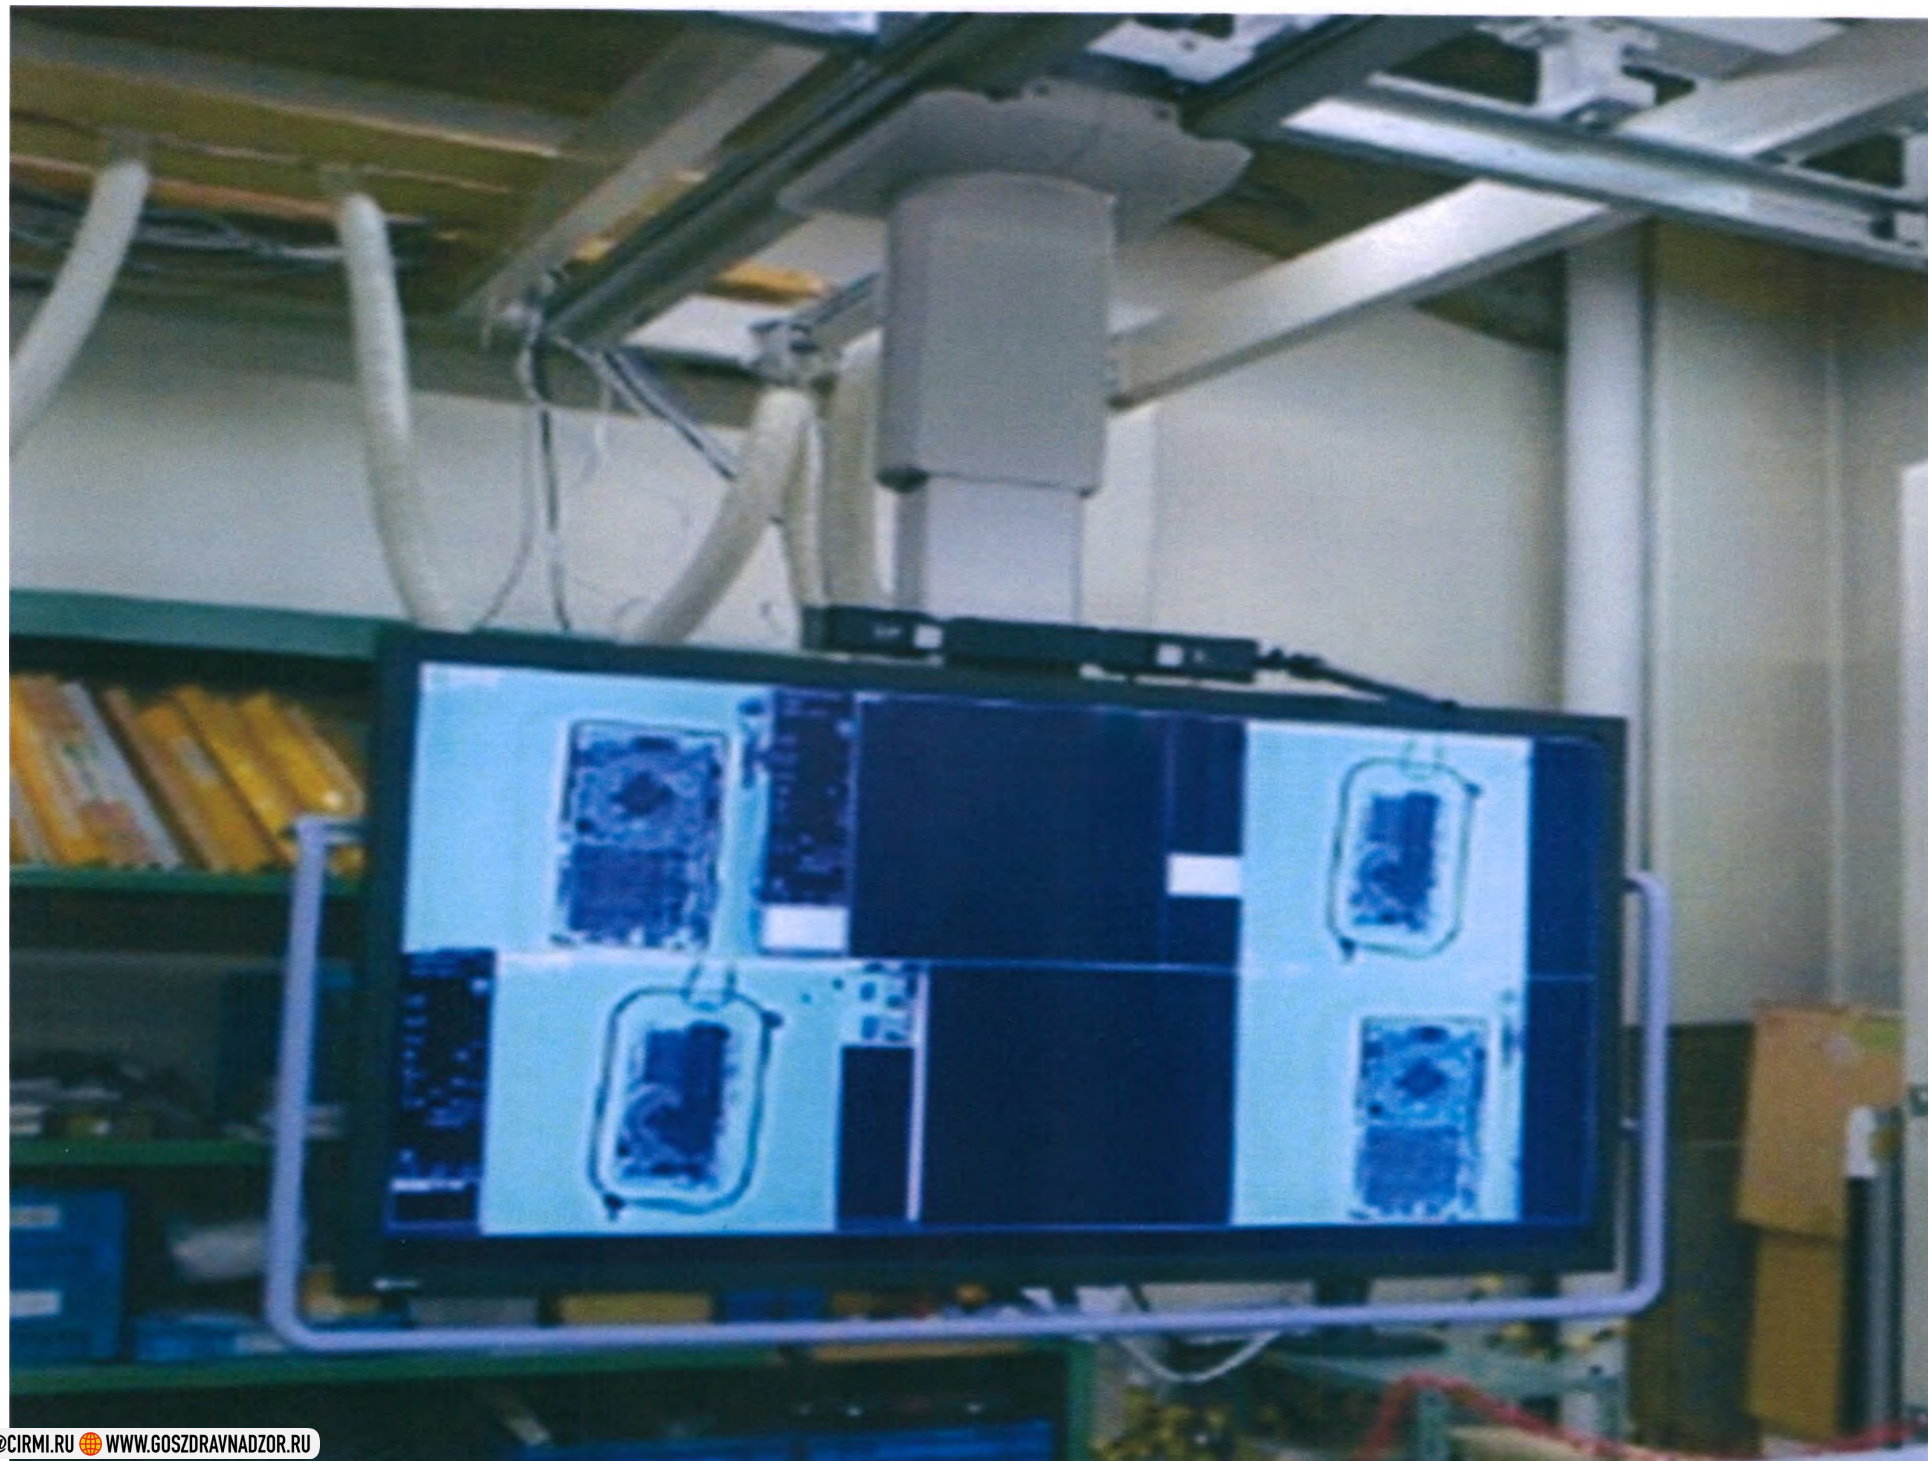



22. Комплект двухпроекционной системы.

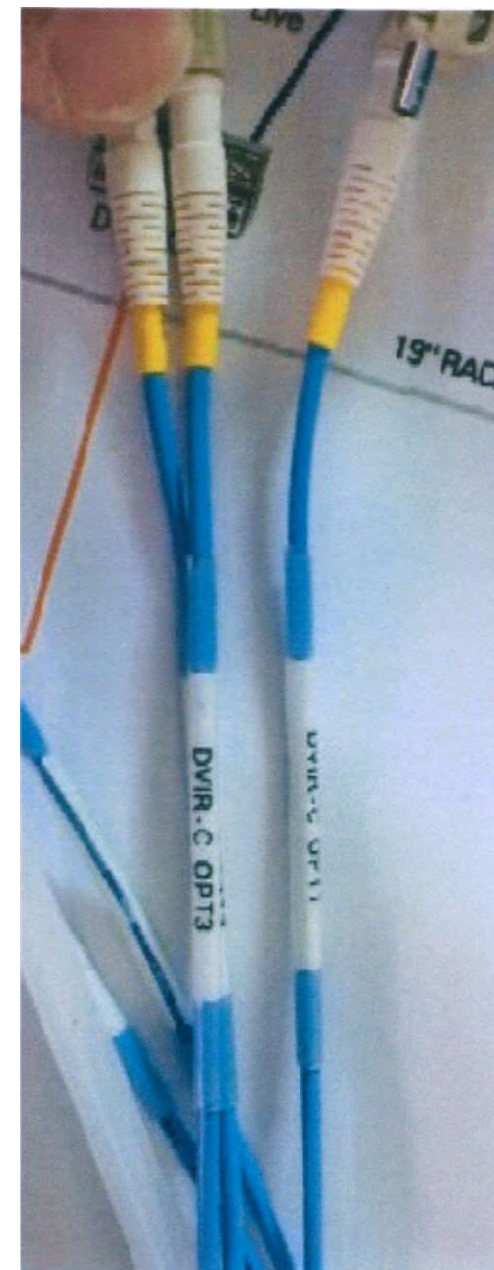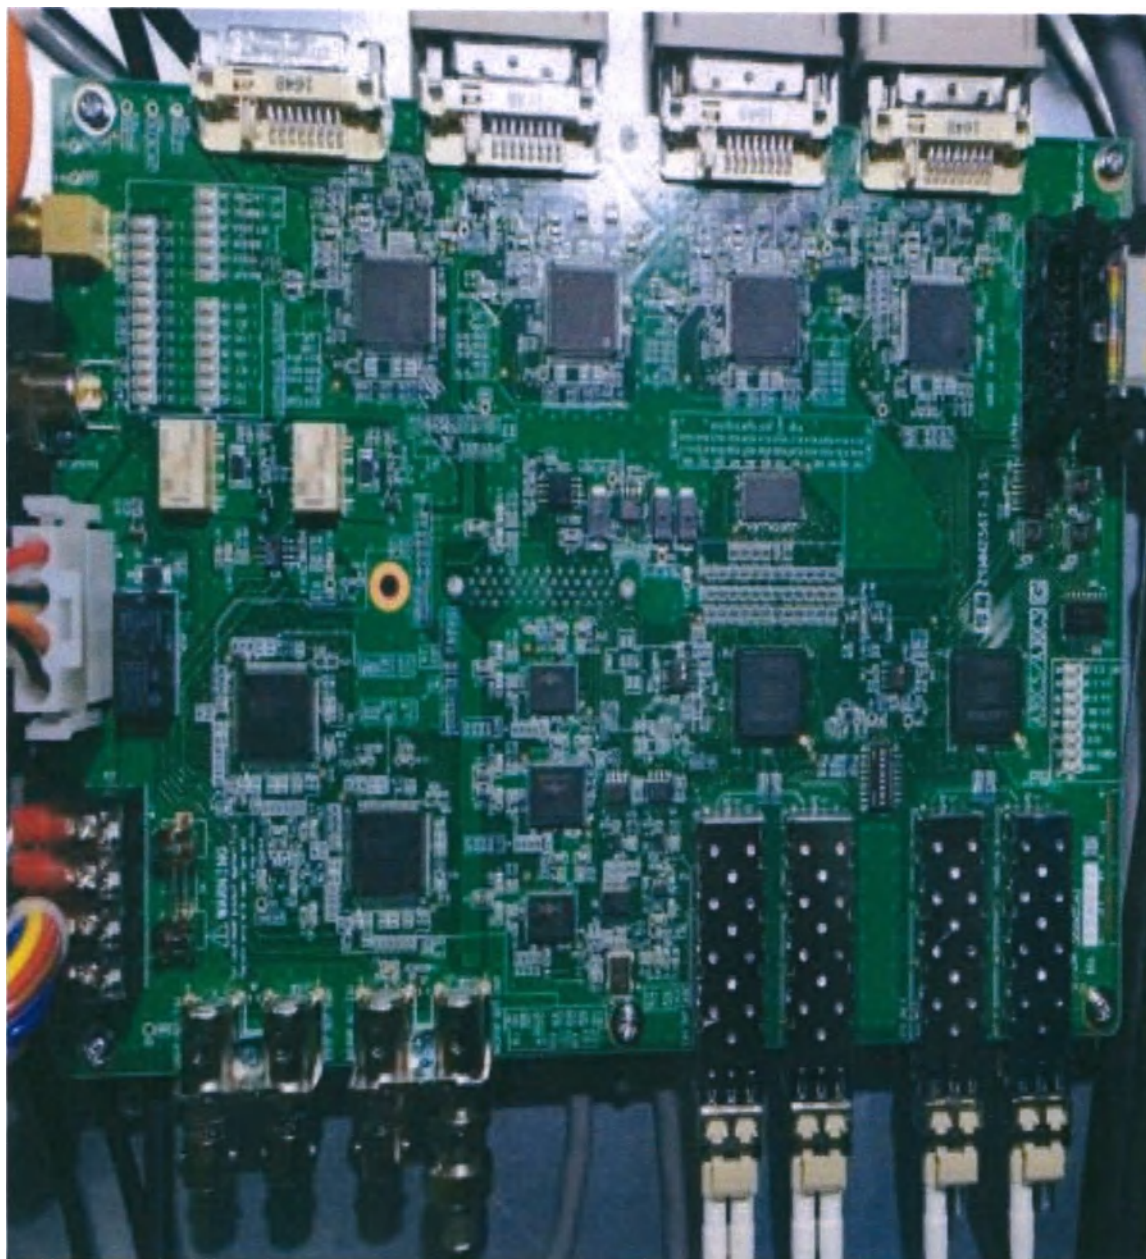



Микрофон в кабинете управления (talk microphone)



Усилитель звуковых сигналов в кабинете управления (talk amp)




Микрофон в кабинете сканирования (listen mic)




Усилитель звуковых сигналов в кабинете сканирования (listen amp)

24. Ионизационная камера дозиметра (производитель PTW-Freiburg, Германия).

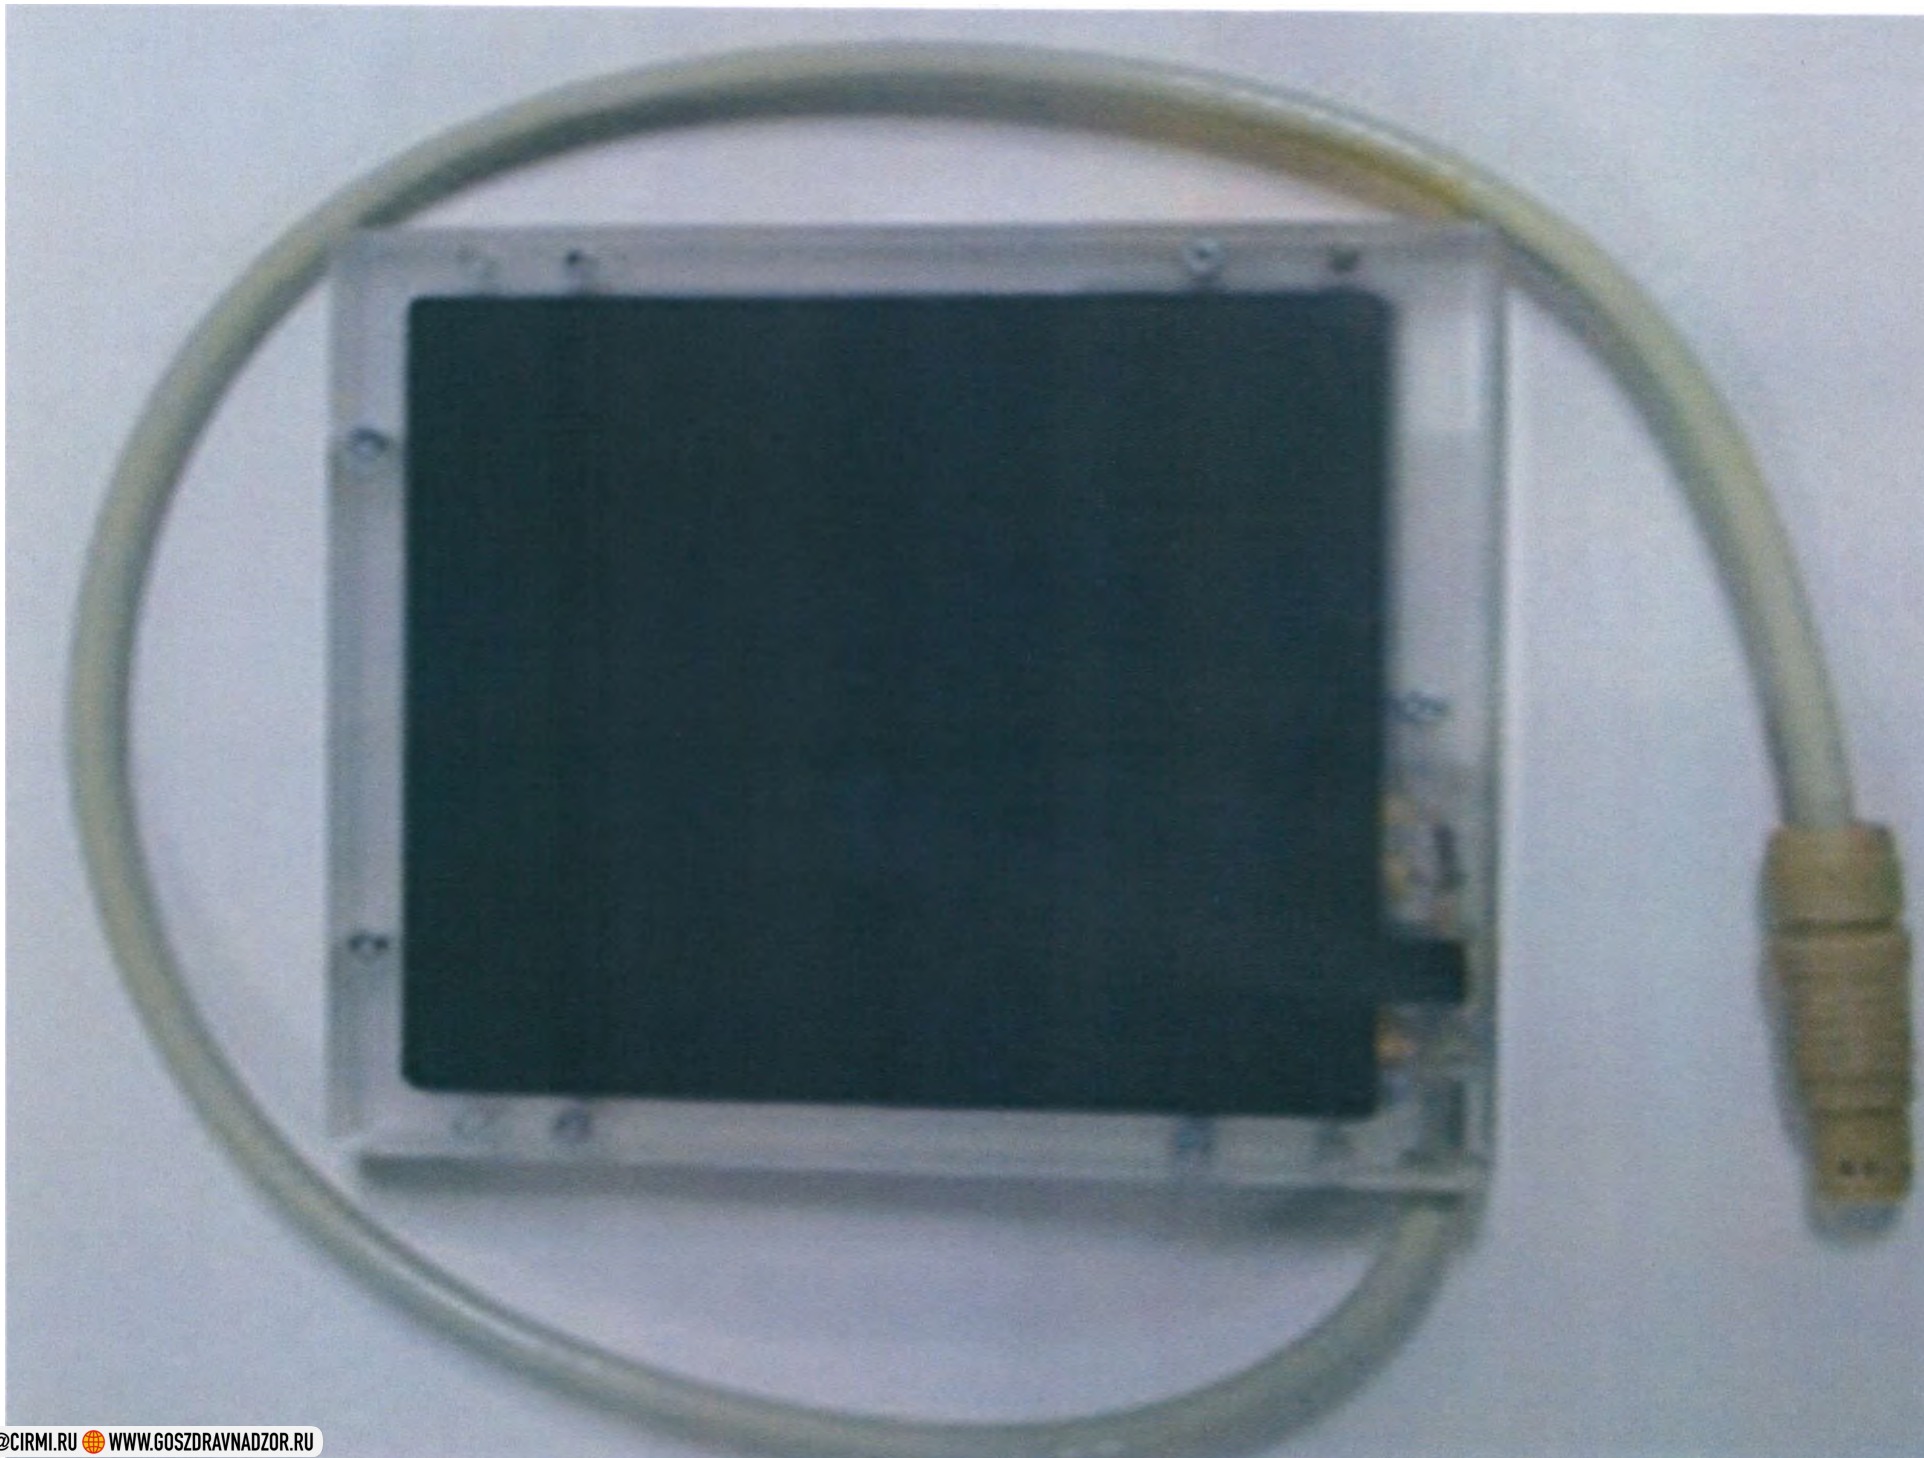





26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - усилитель – 1 шт.

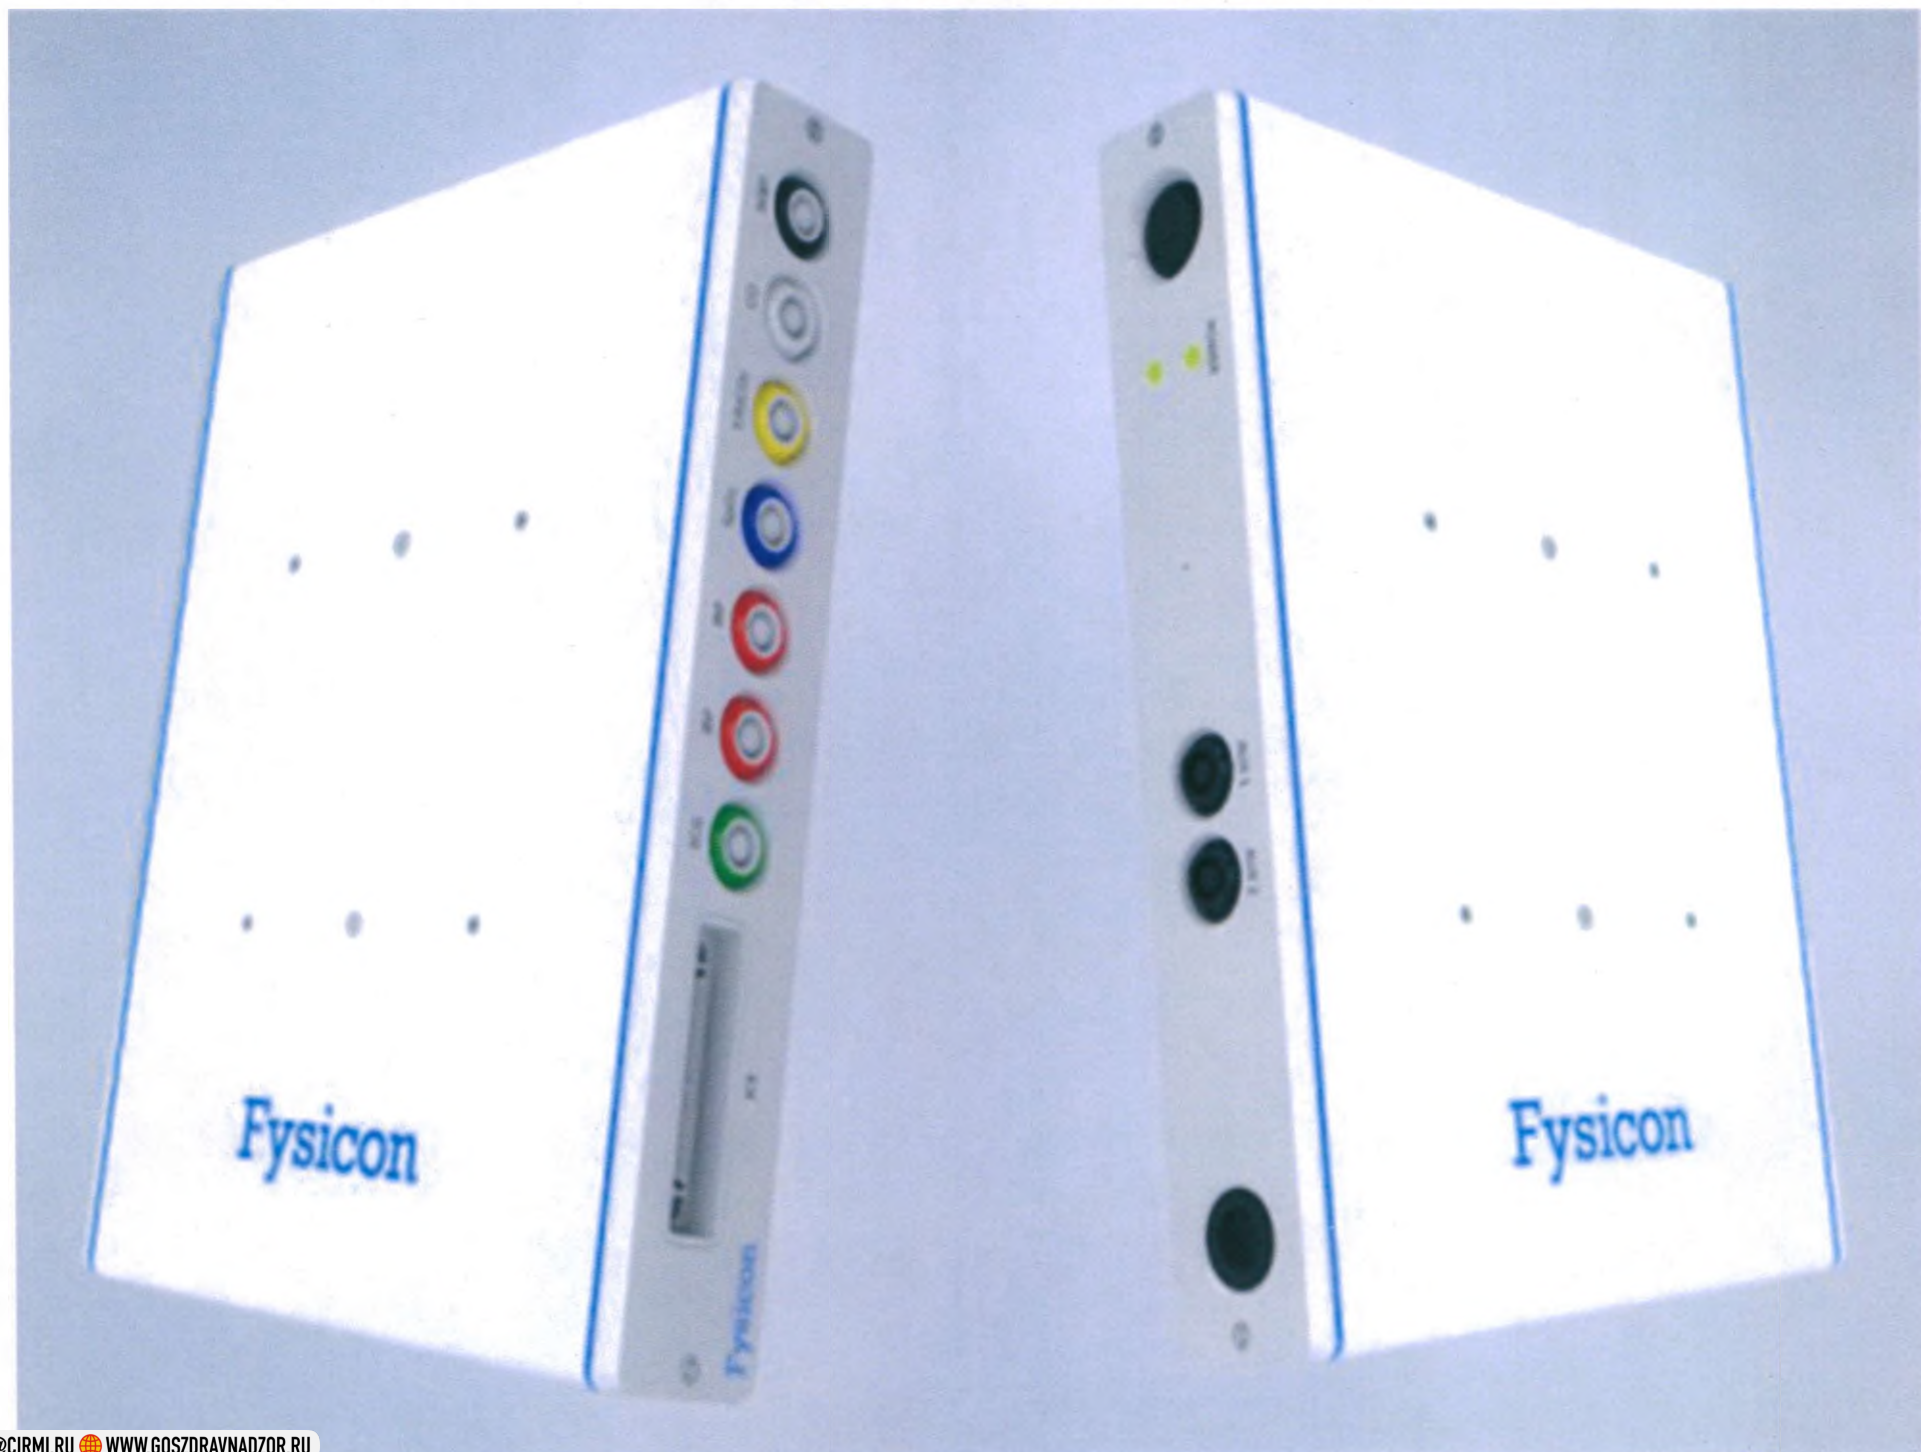


26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - крепеж для DIN-рейки - 1 шт.;

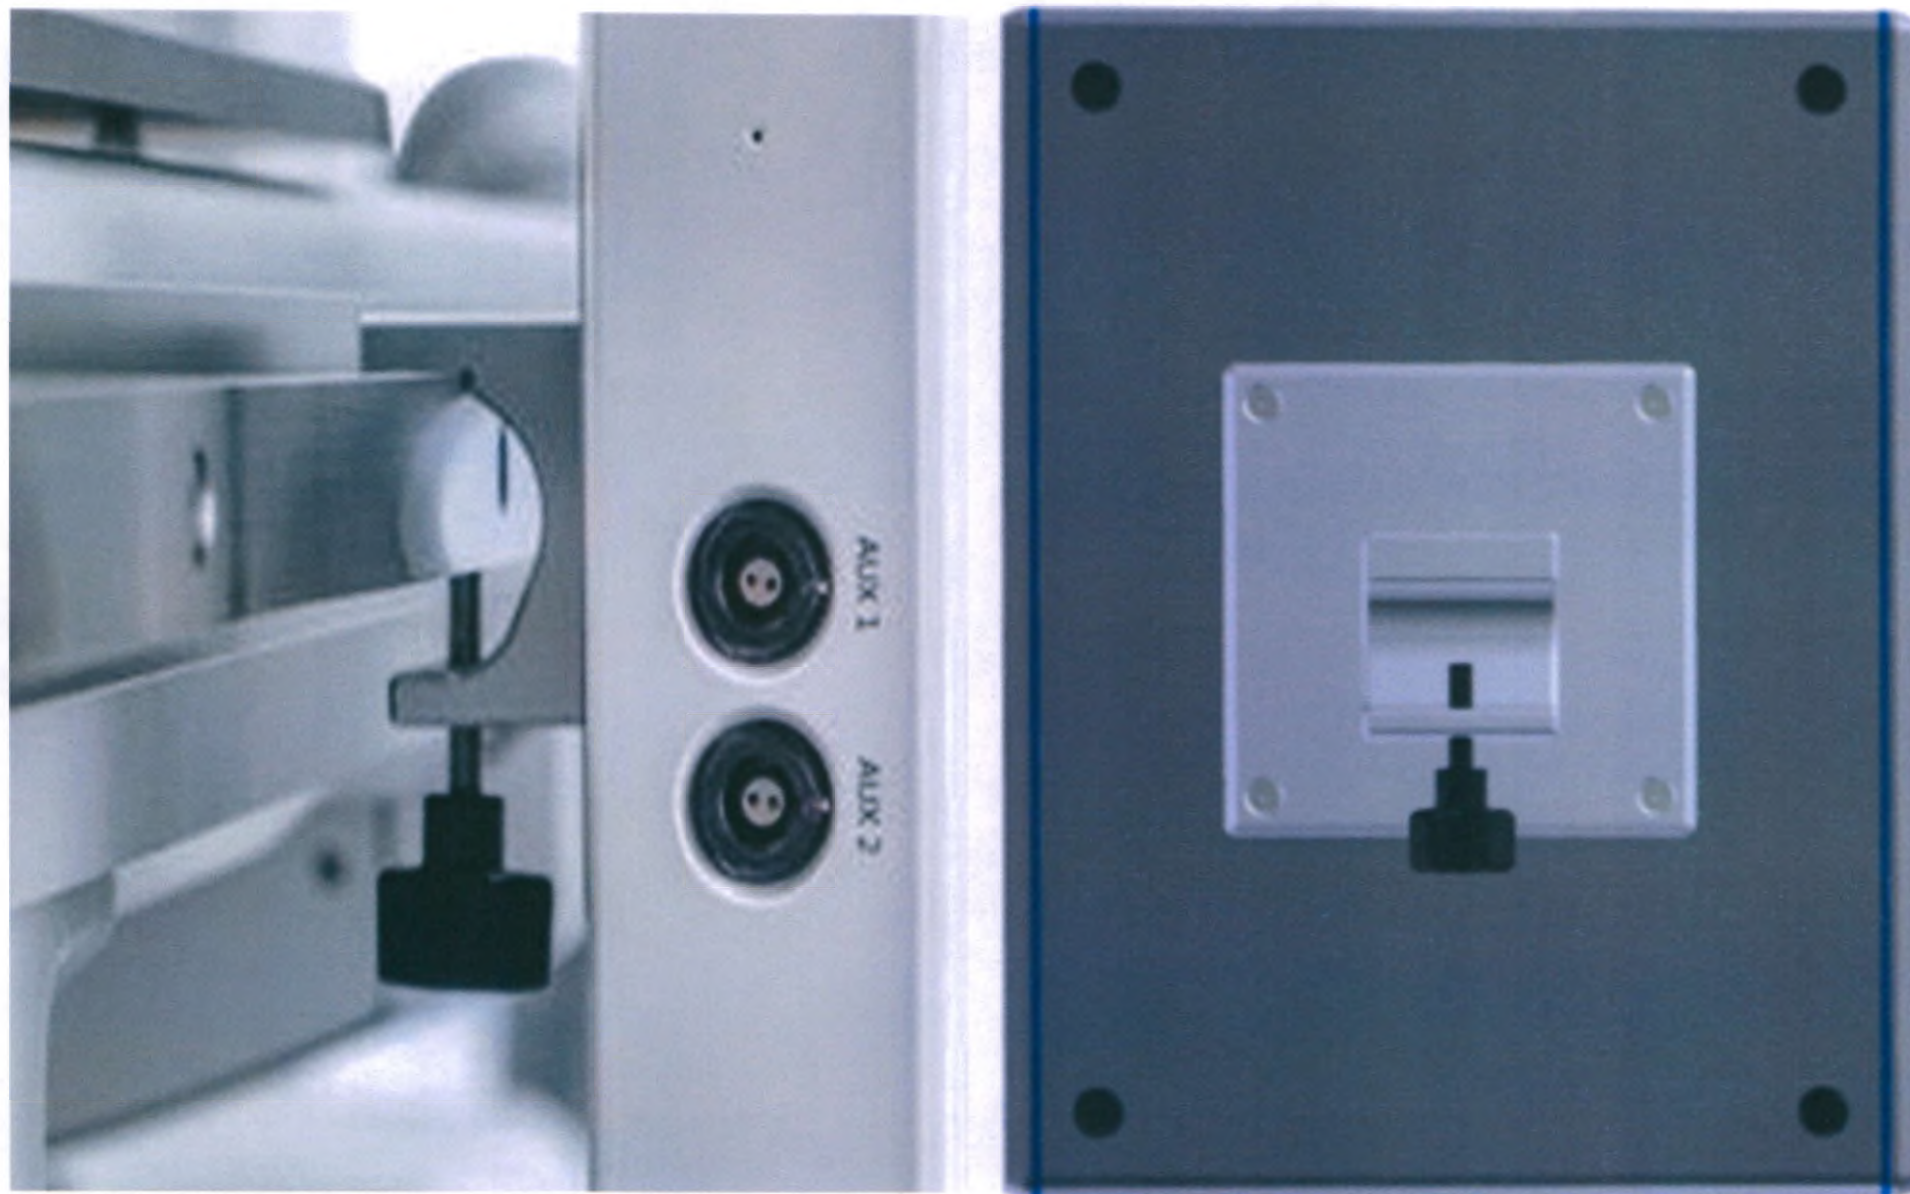


26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - процессор отчетов – 1 шт.; - процессор для работы в реальном времени (при необходимости), 1 шт.;

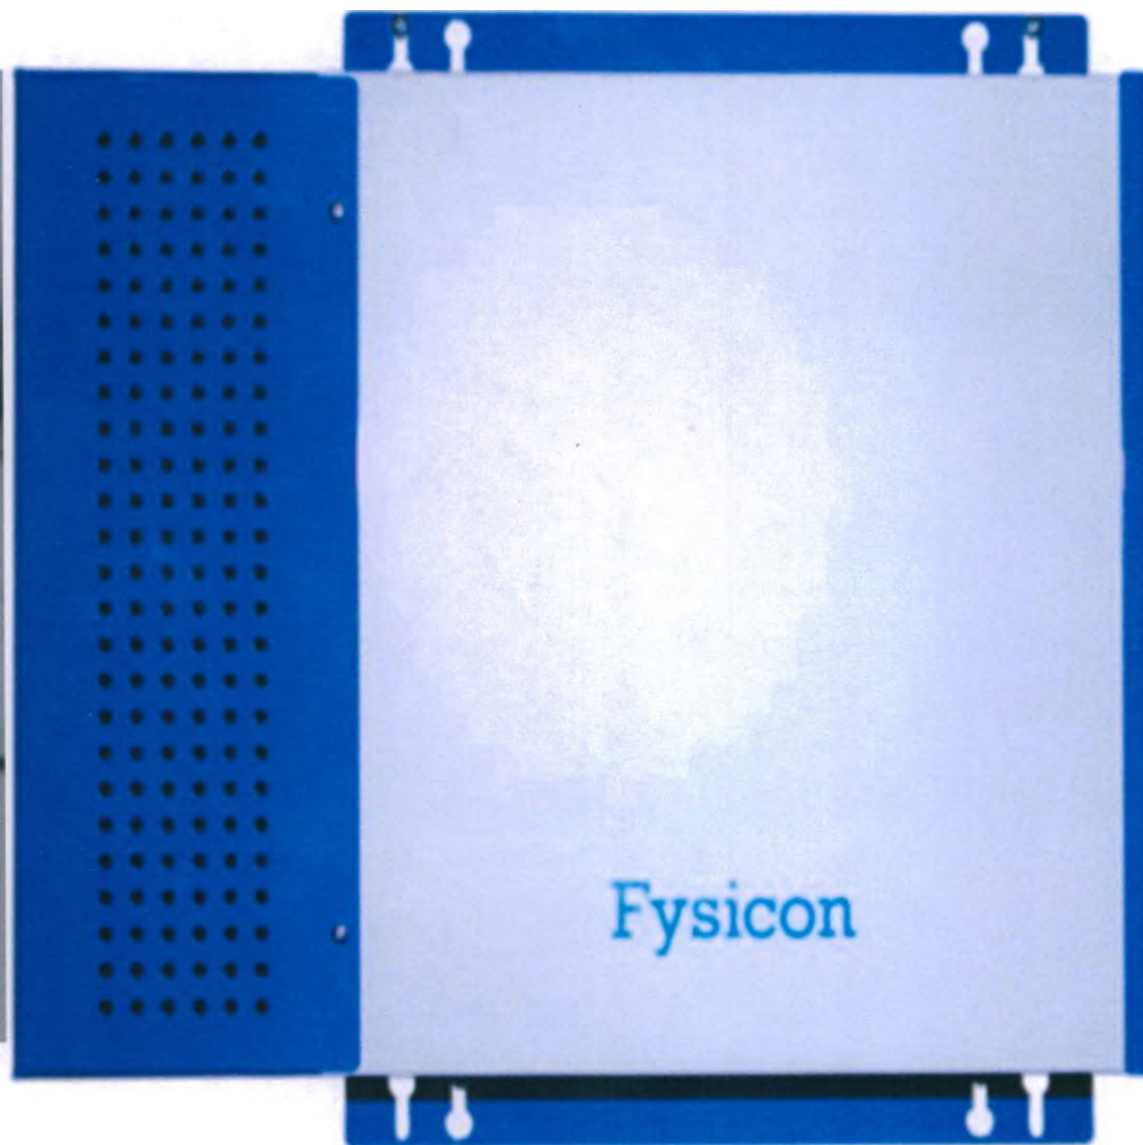

26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - кабель системы, не более 3 шт.

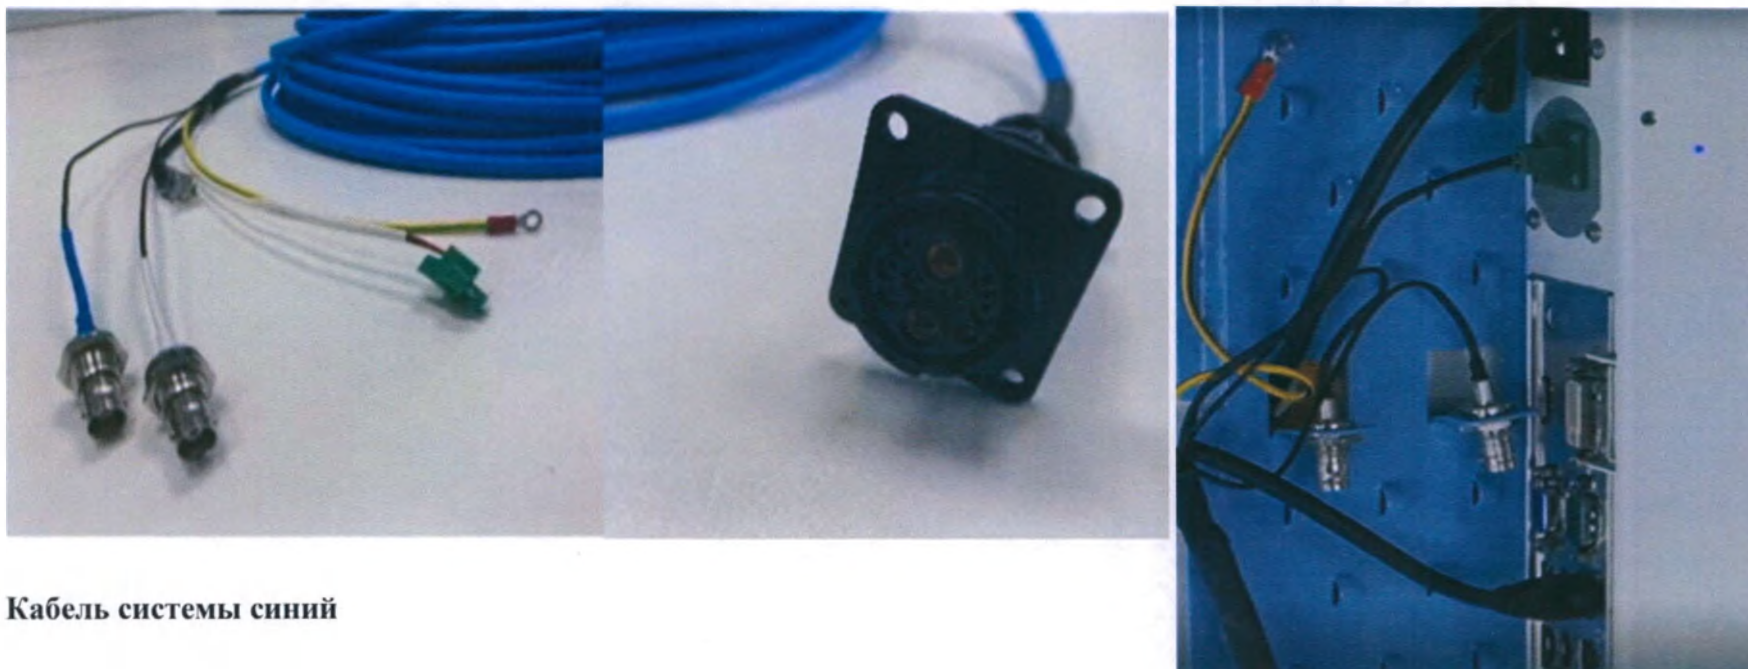

Кабель системы синий

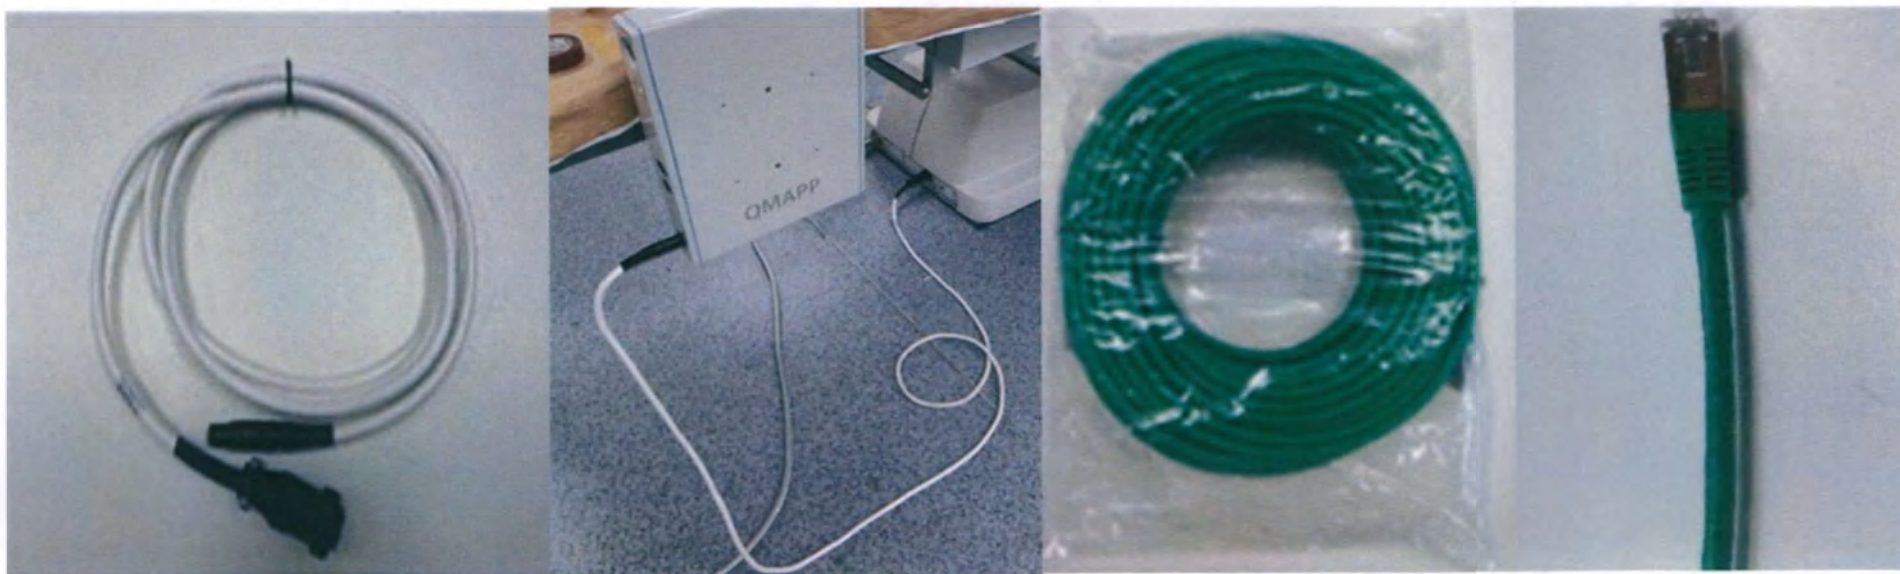

Кабель системы белый

Кабель информационный зеленый

26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - адаптер питания, не более 3 шт.





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Alphenix

**МОДЕЛЬ INFX-8000V/B, INFX-8000V/Y,
INFX-8000V/P**

ВАЖНО!

Перед эксплуатацией оборудования ознакомьтесь
с настоящим руководством. После прочтения
держите руководство в легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2018–2020

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Принадлежности: 1. Вспомогательная консоль для двухпроекционной системы




1. Вспомогательная консоль для двухпроекционной системы (Подставка)




2. Боковая консоль стола (для использования в сочетании с планшетной консолью) для двухпроекционной системы.



3. Опорная плита для CAS-880A, 1400 мм.

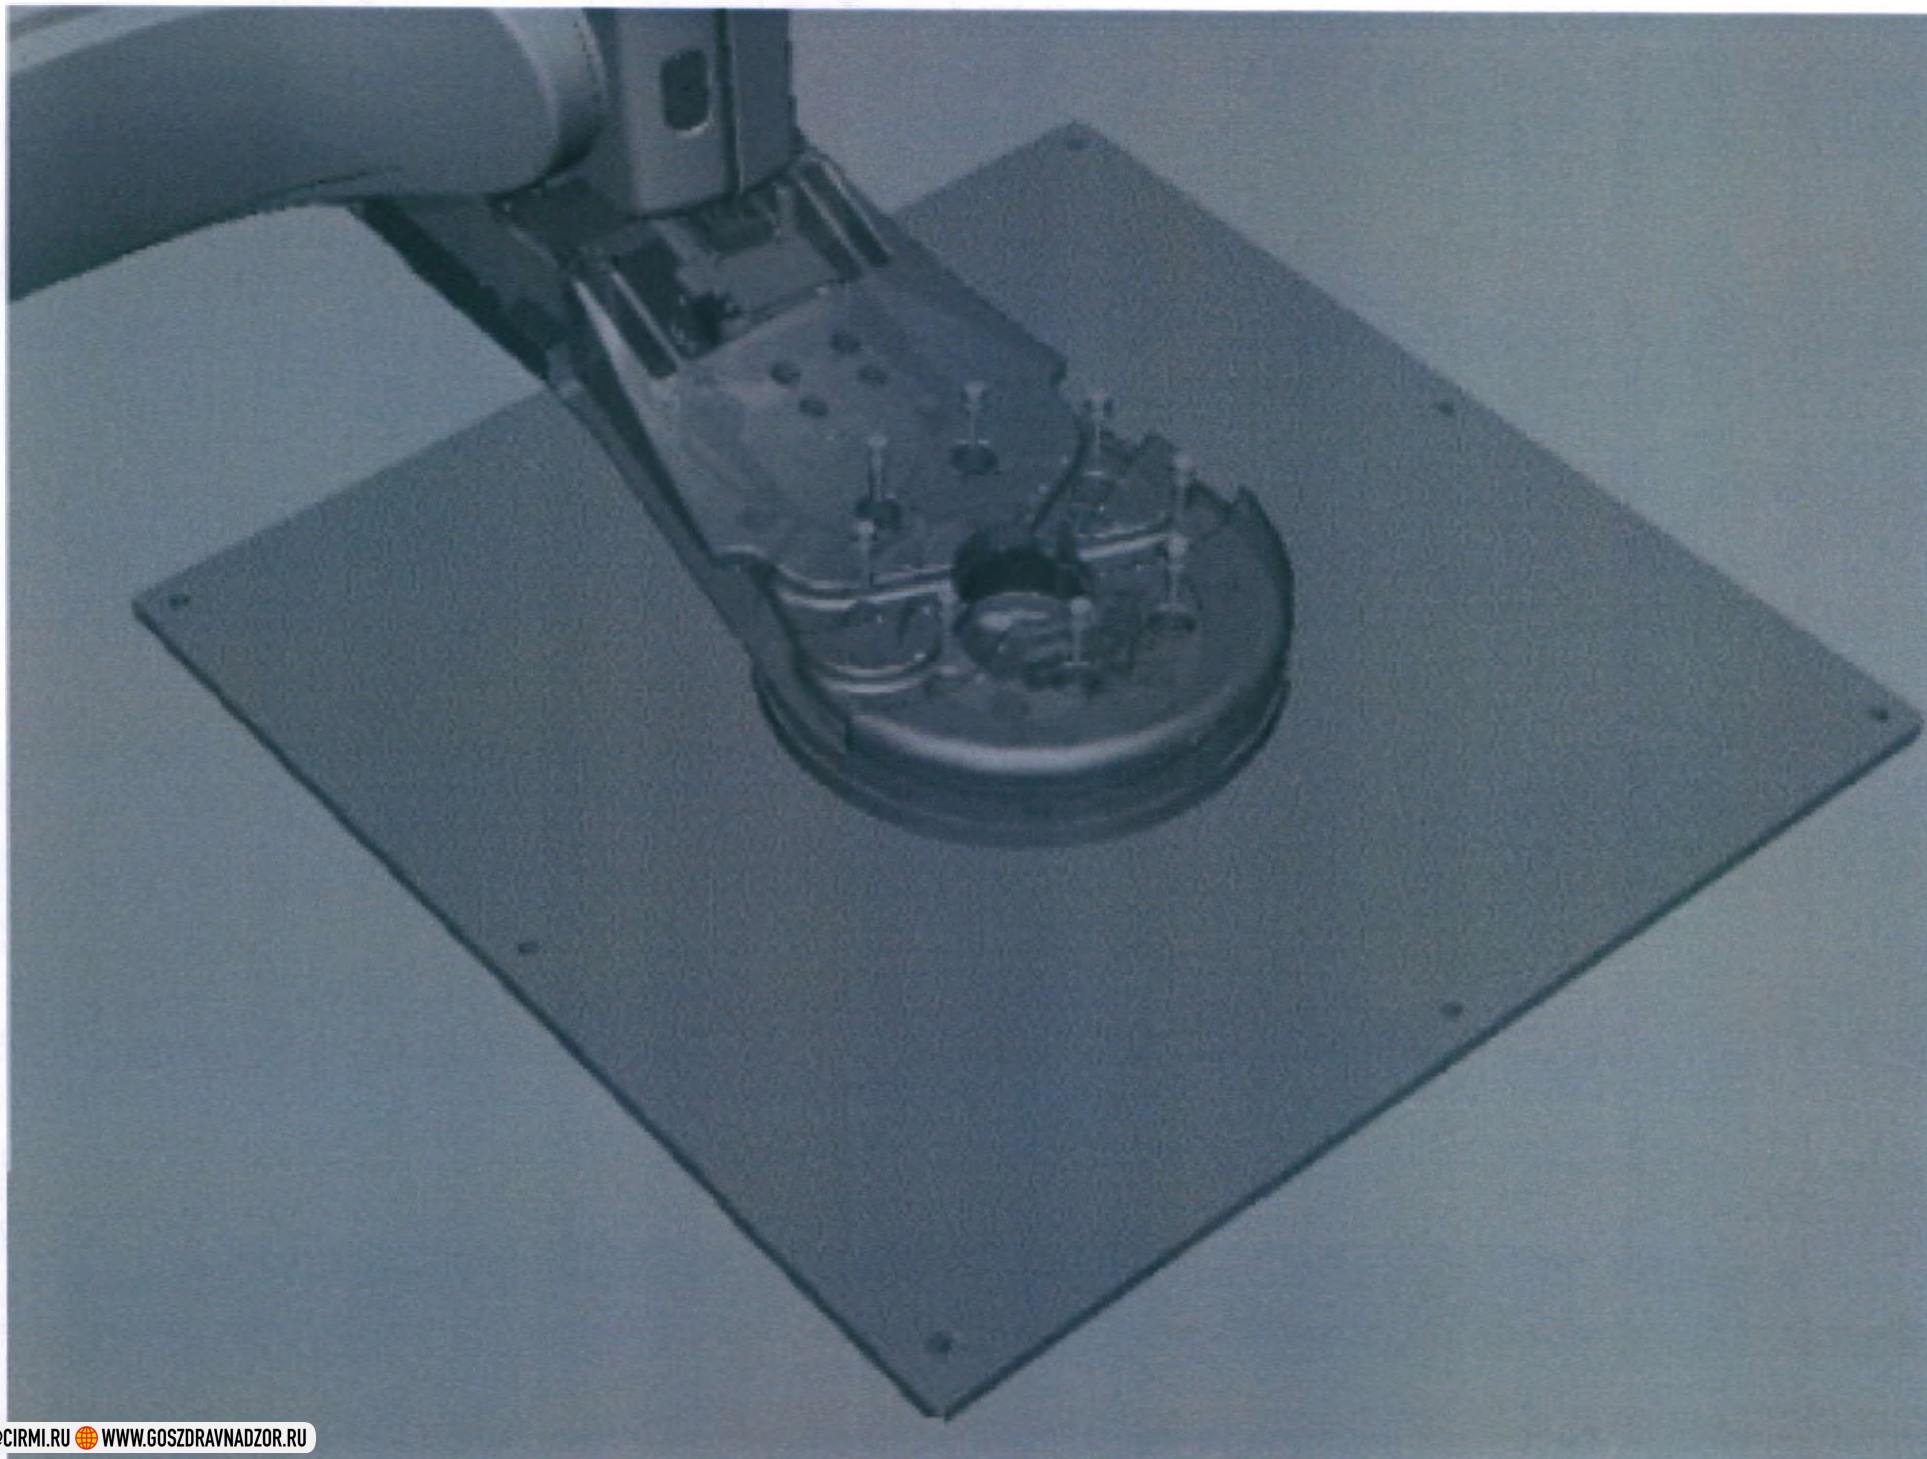

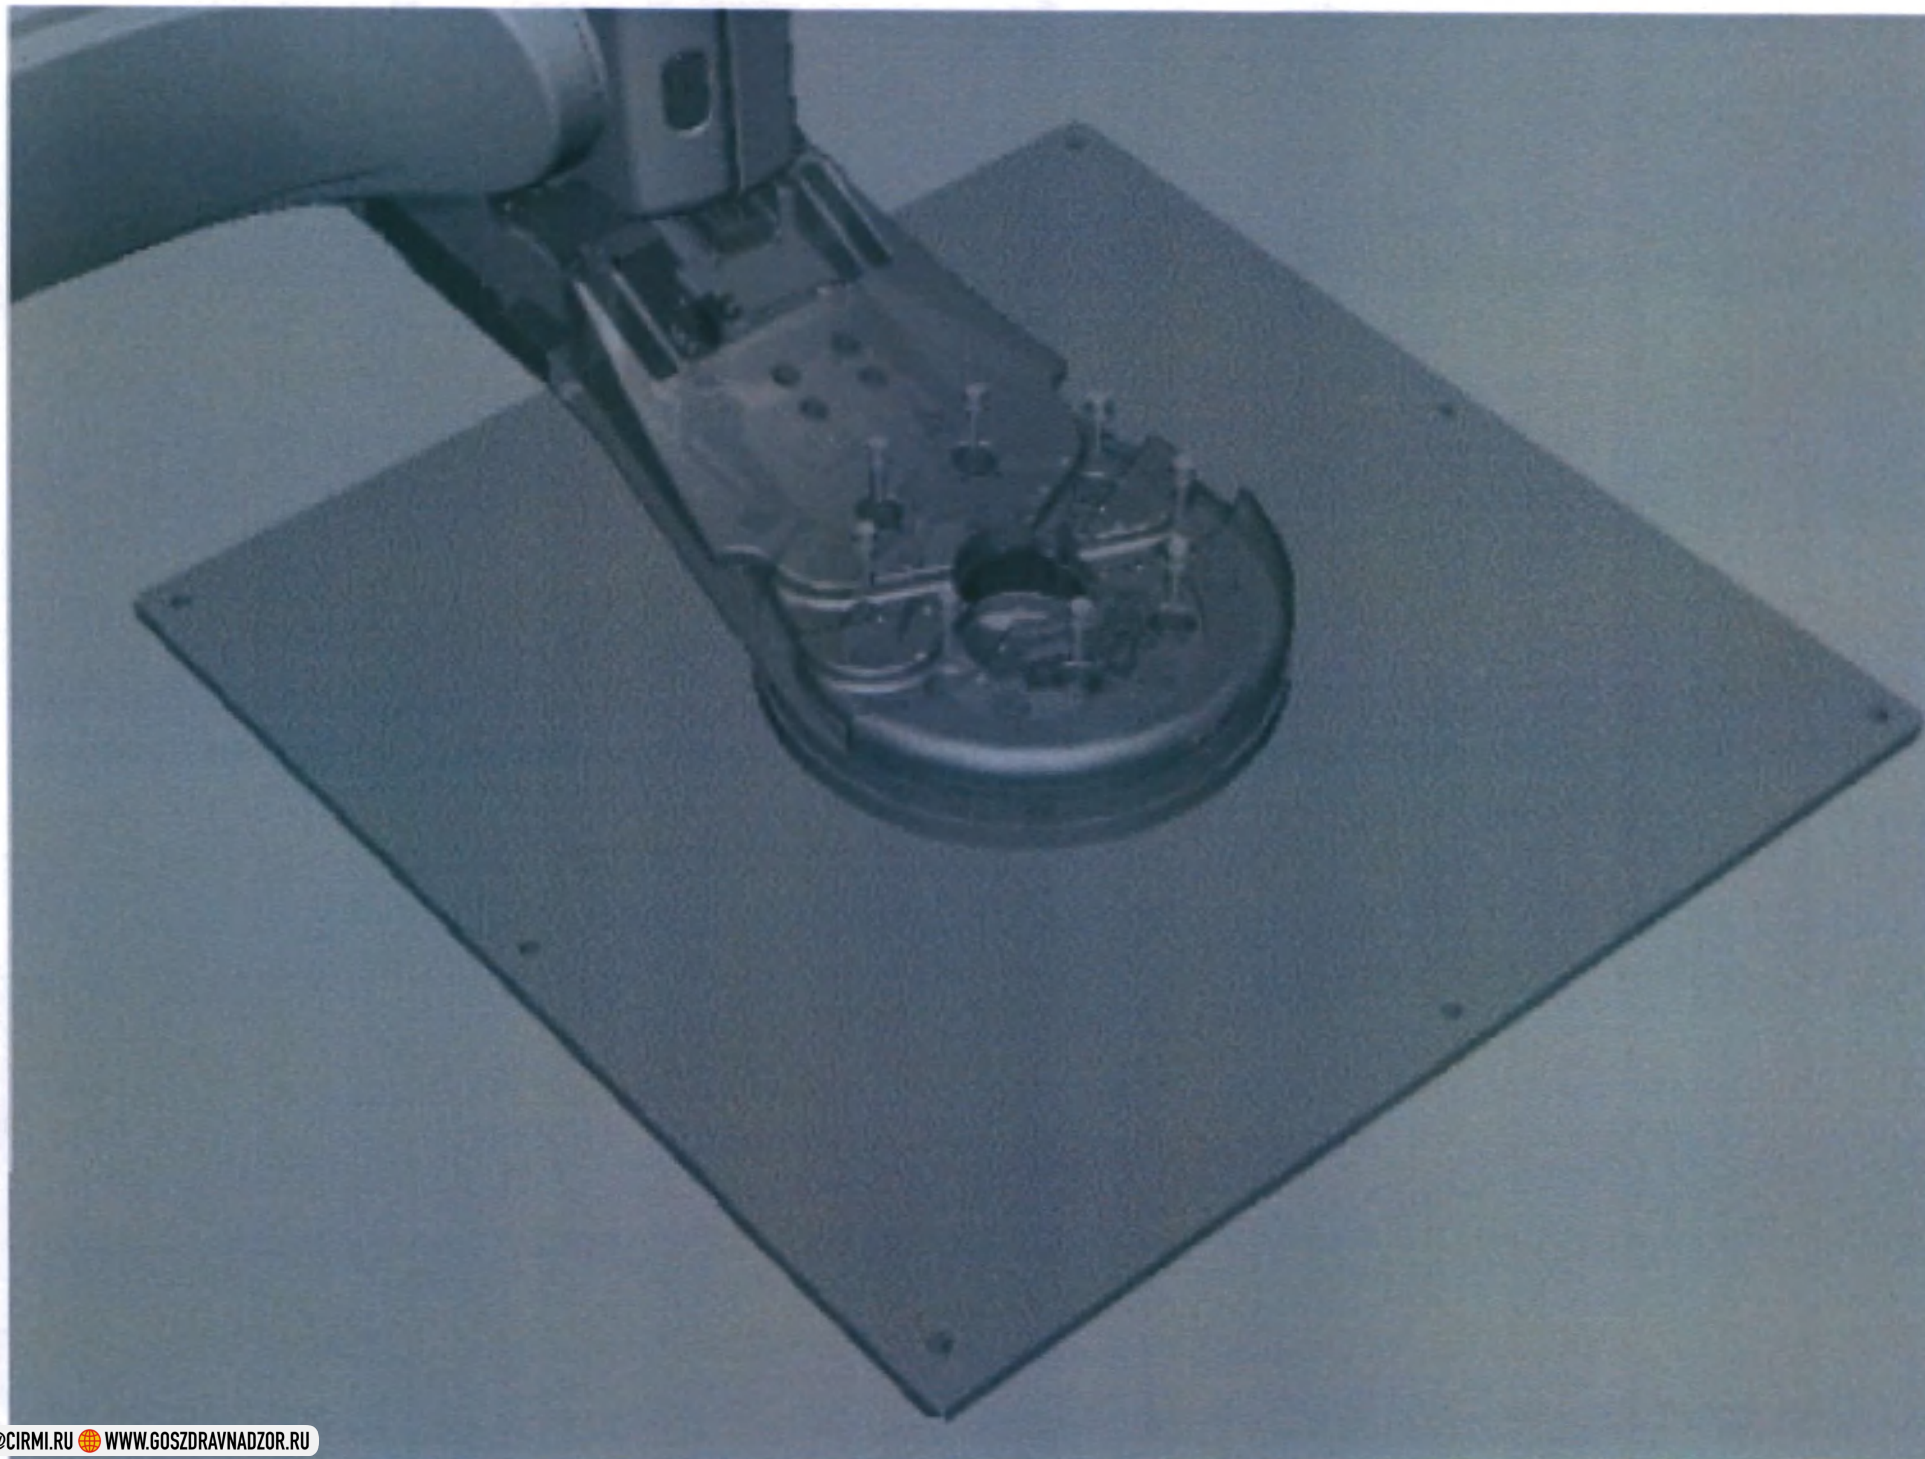

5. Ножной переключатель (дополнительный) для двухпроекционной системы.




6. Беспроводной ножной переключатель для двухпроекционной системы.



Беспроводной ножной переключатель




Сетевой адаптер

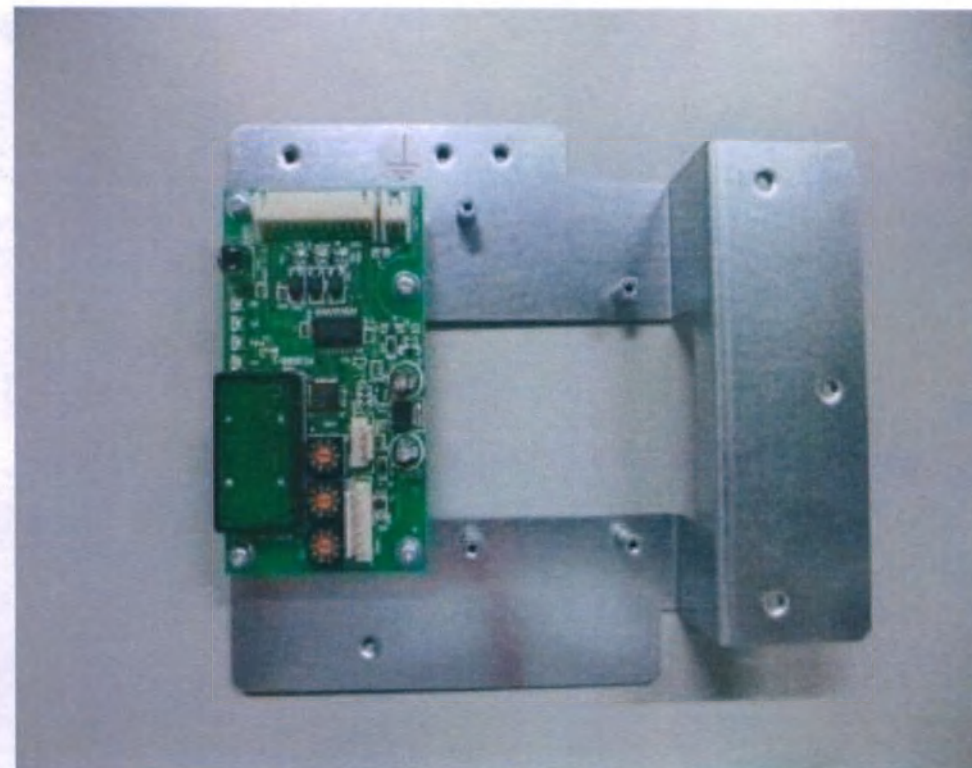



Приемник сигнала

7. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-850В).

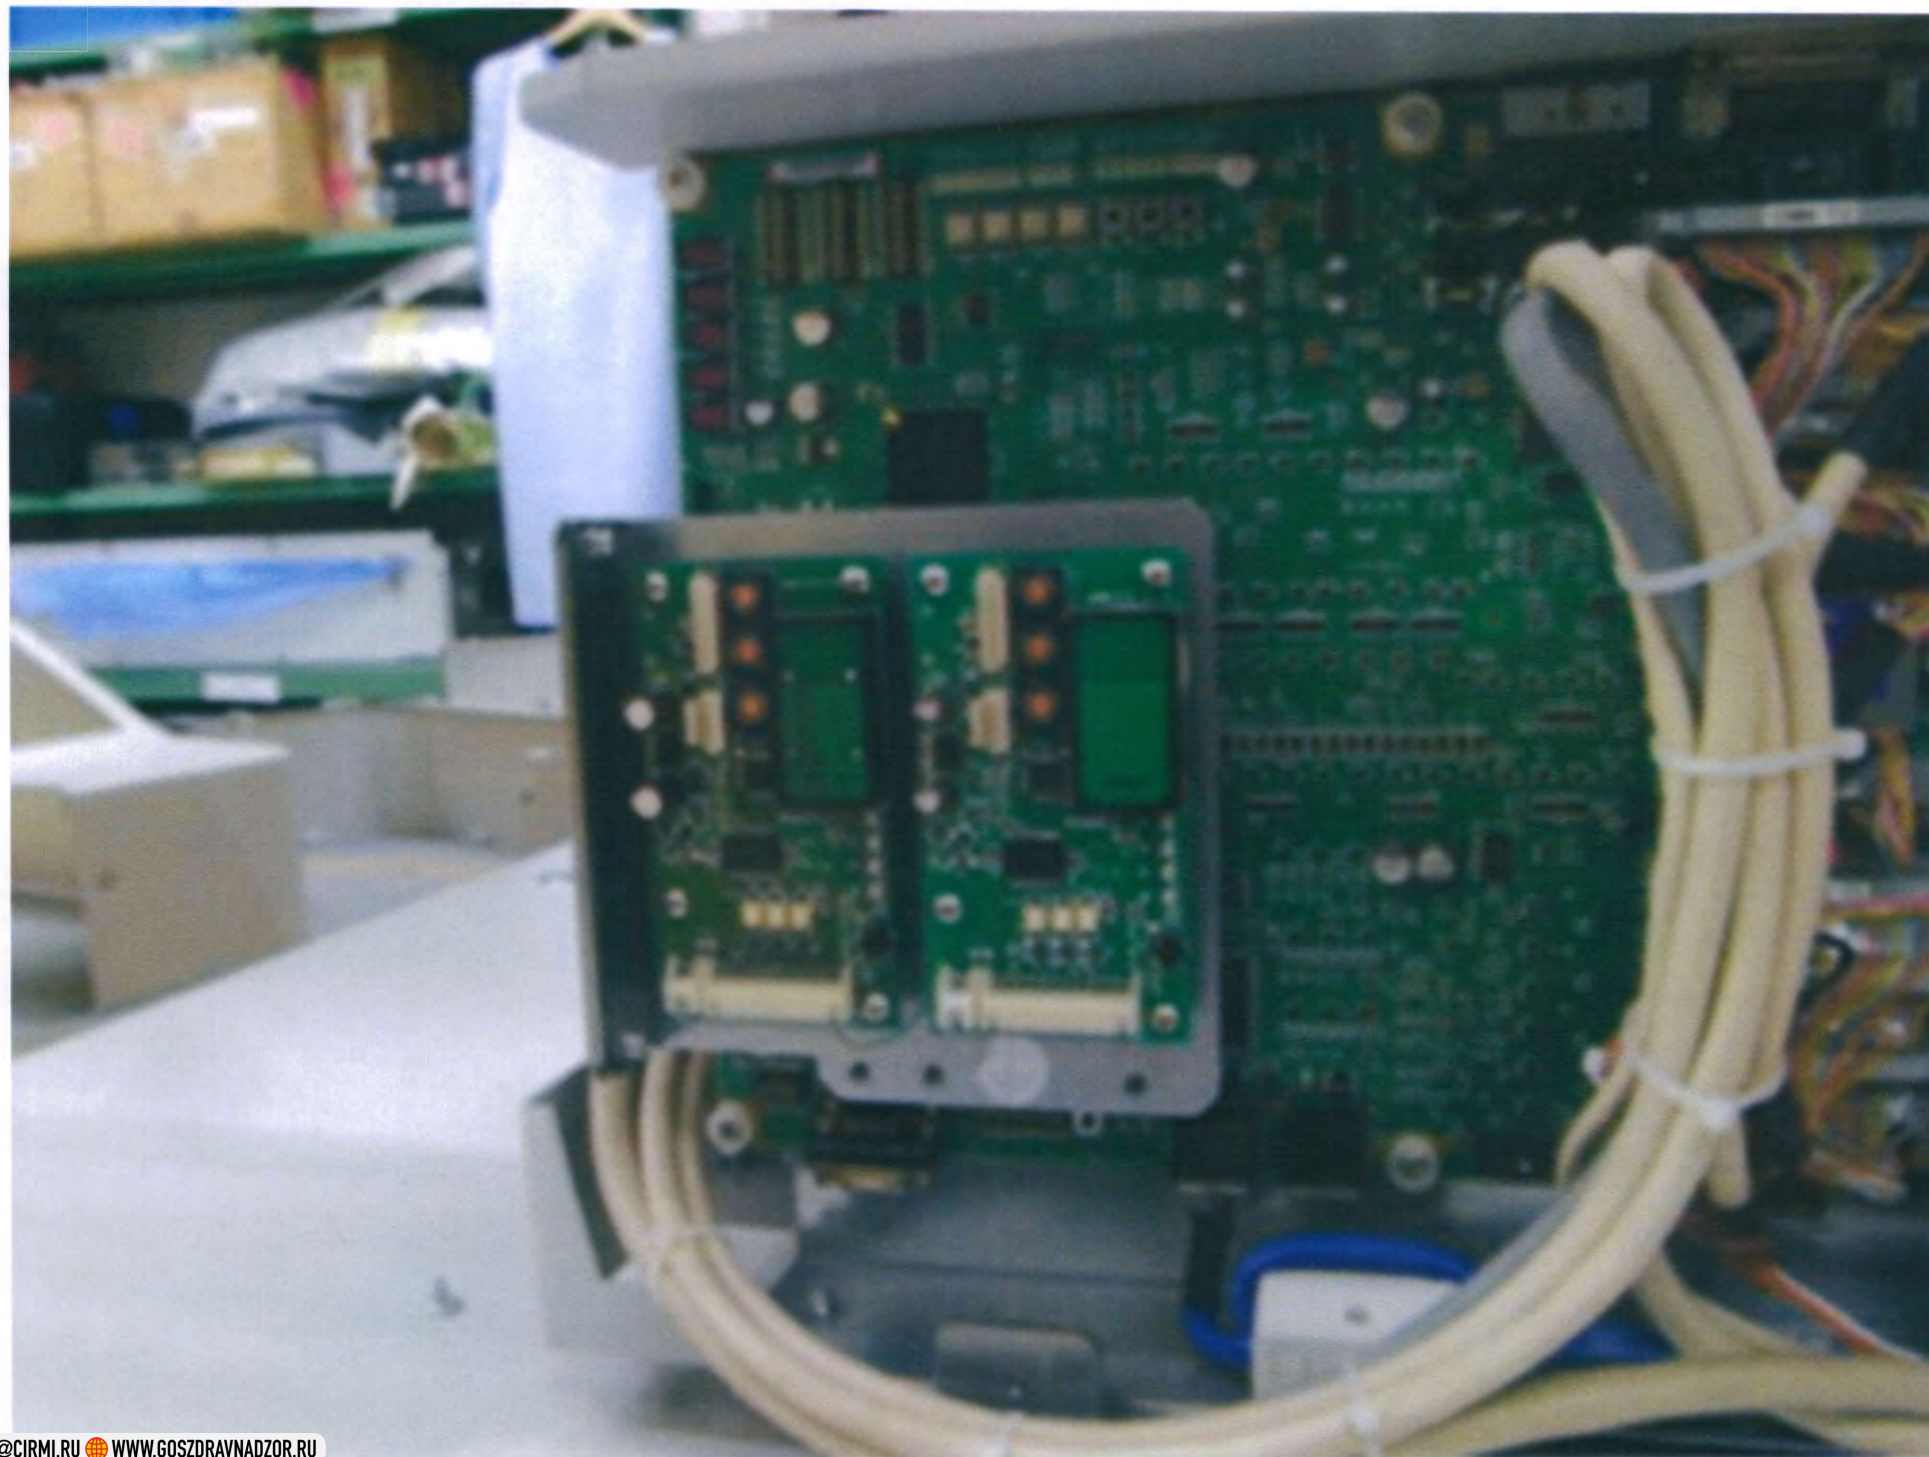


8. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-880В).

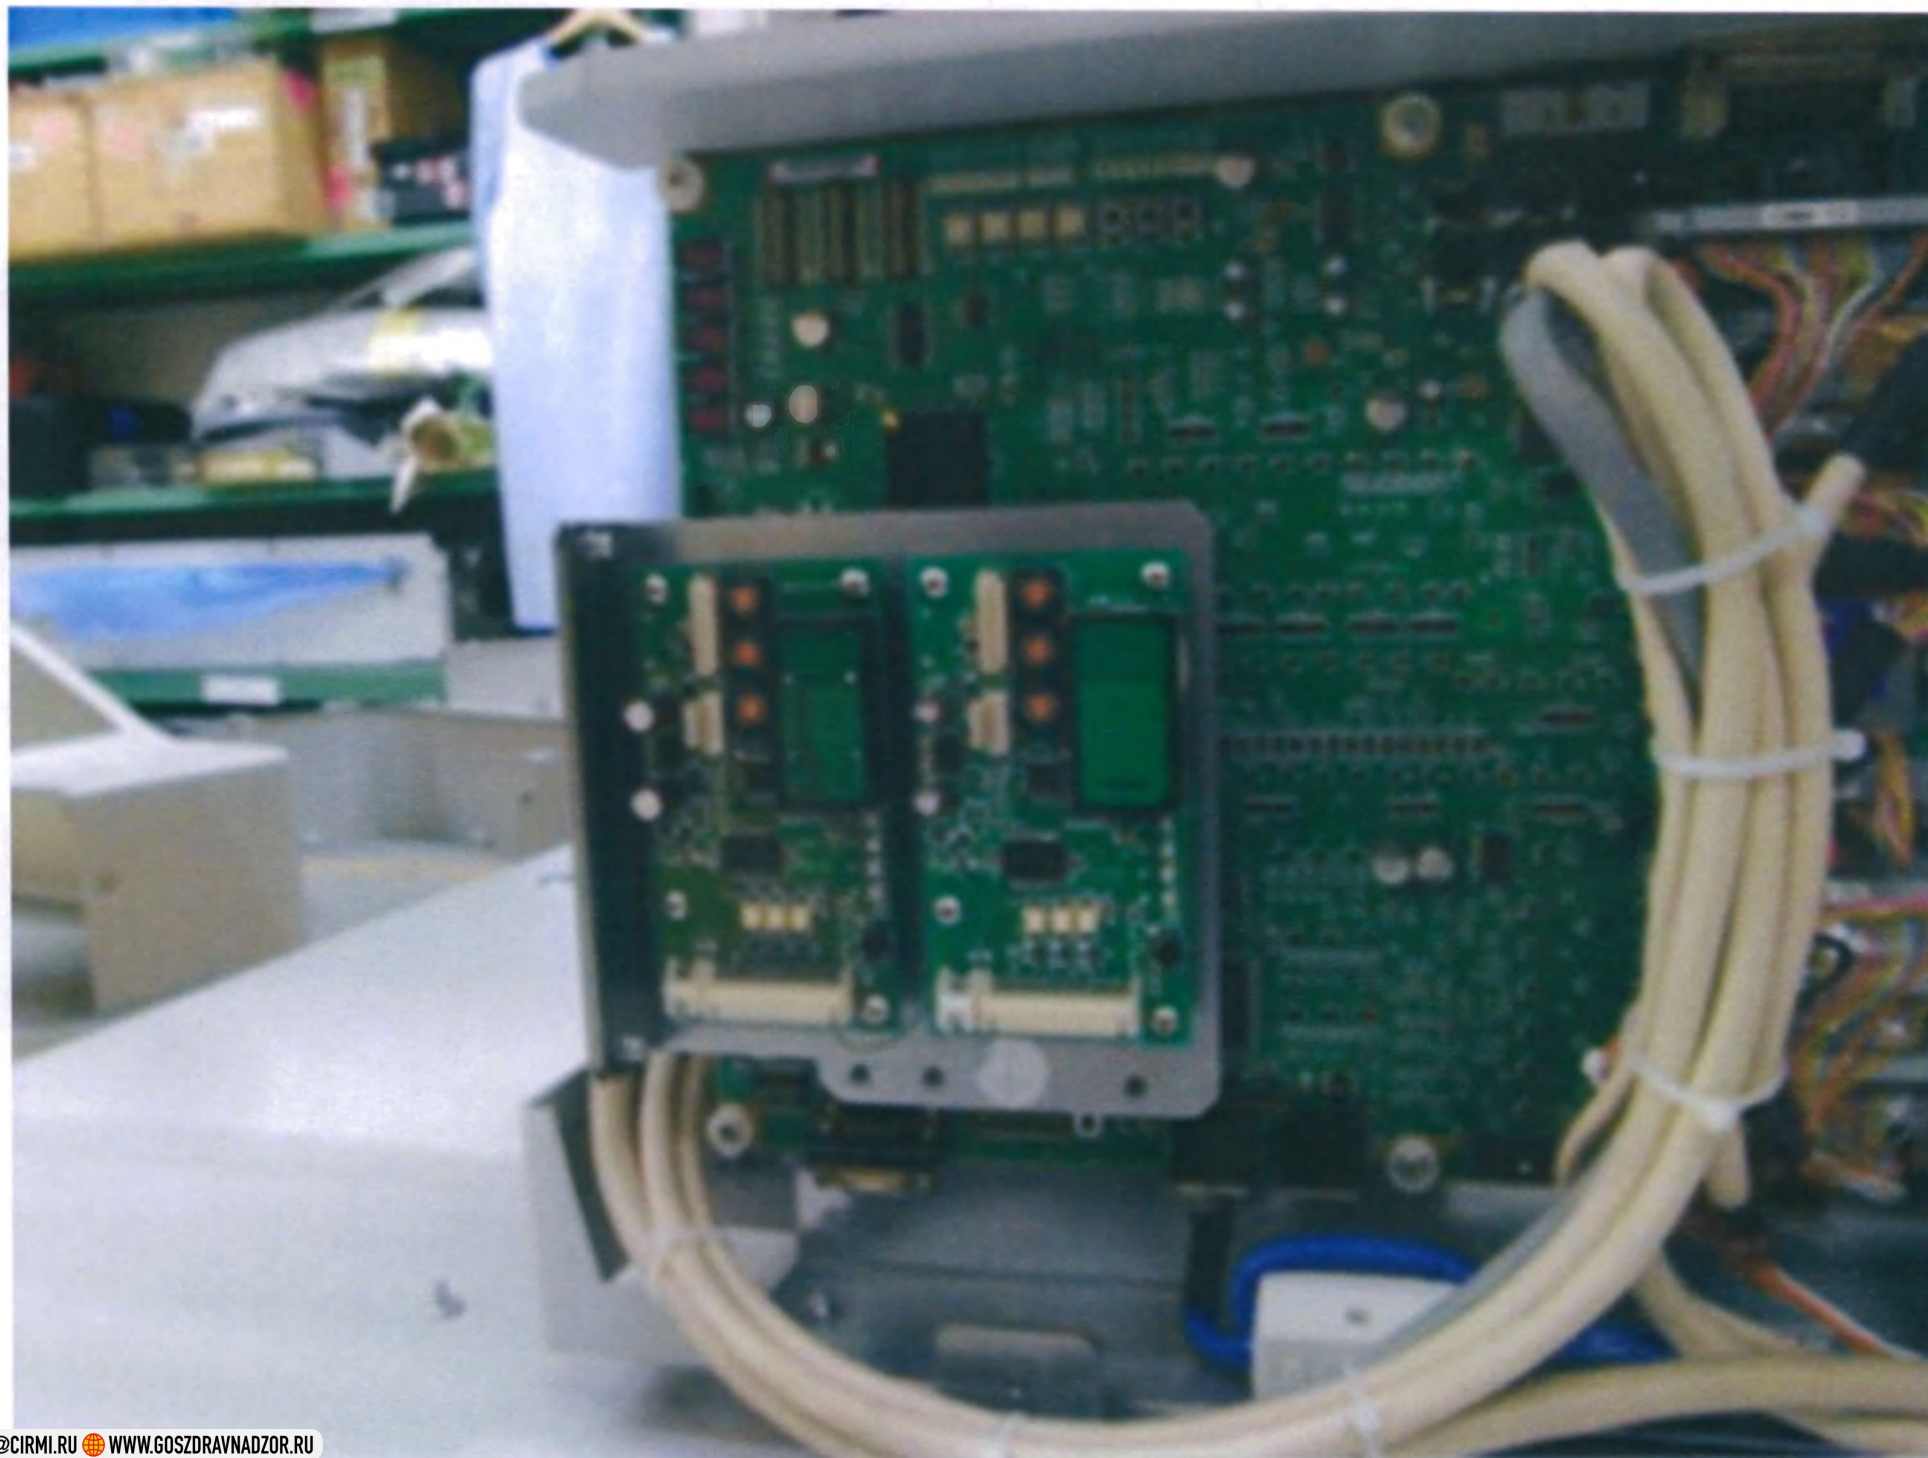

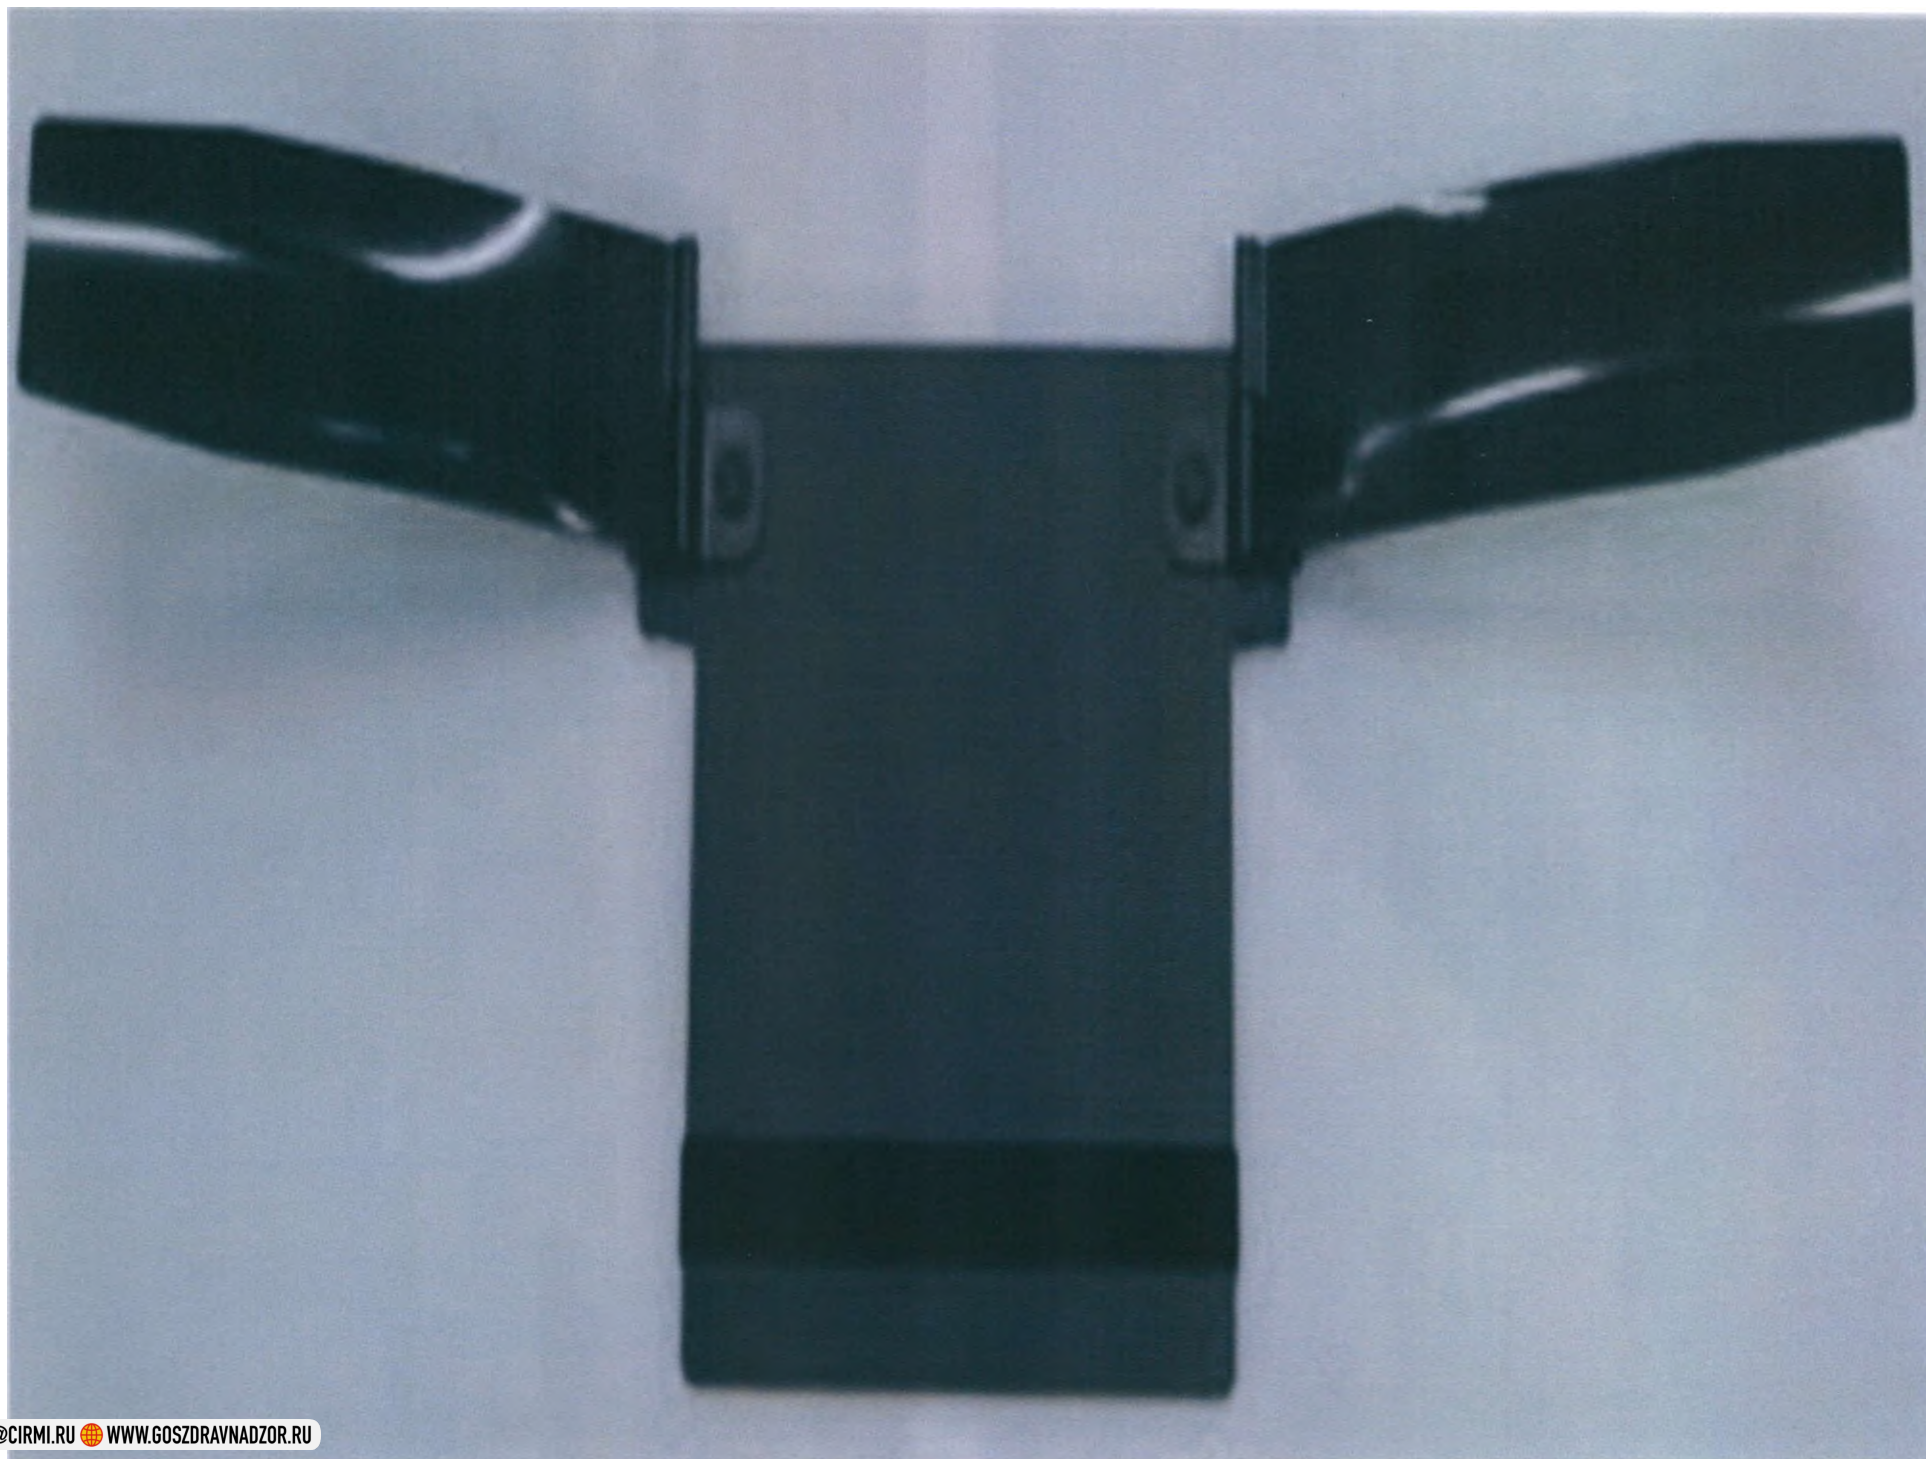


10. Подлокотник для одной руки (для САТ-880В).

ЧЗУ

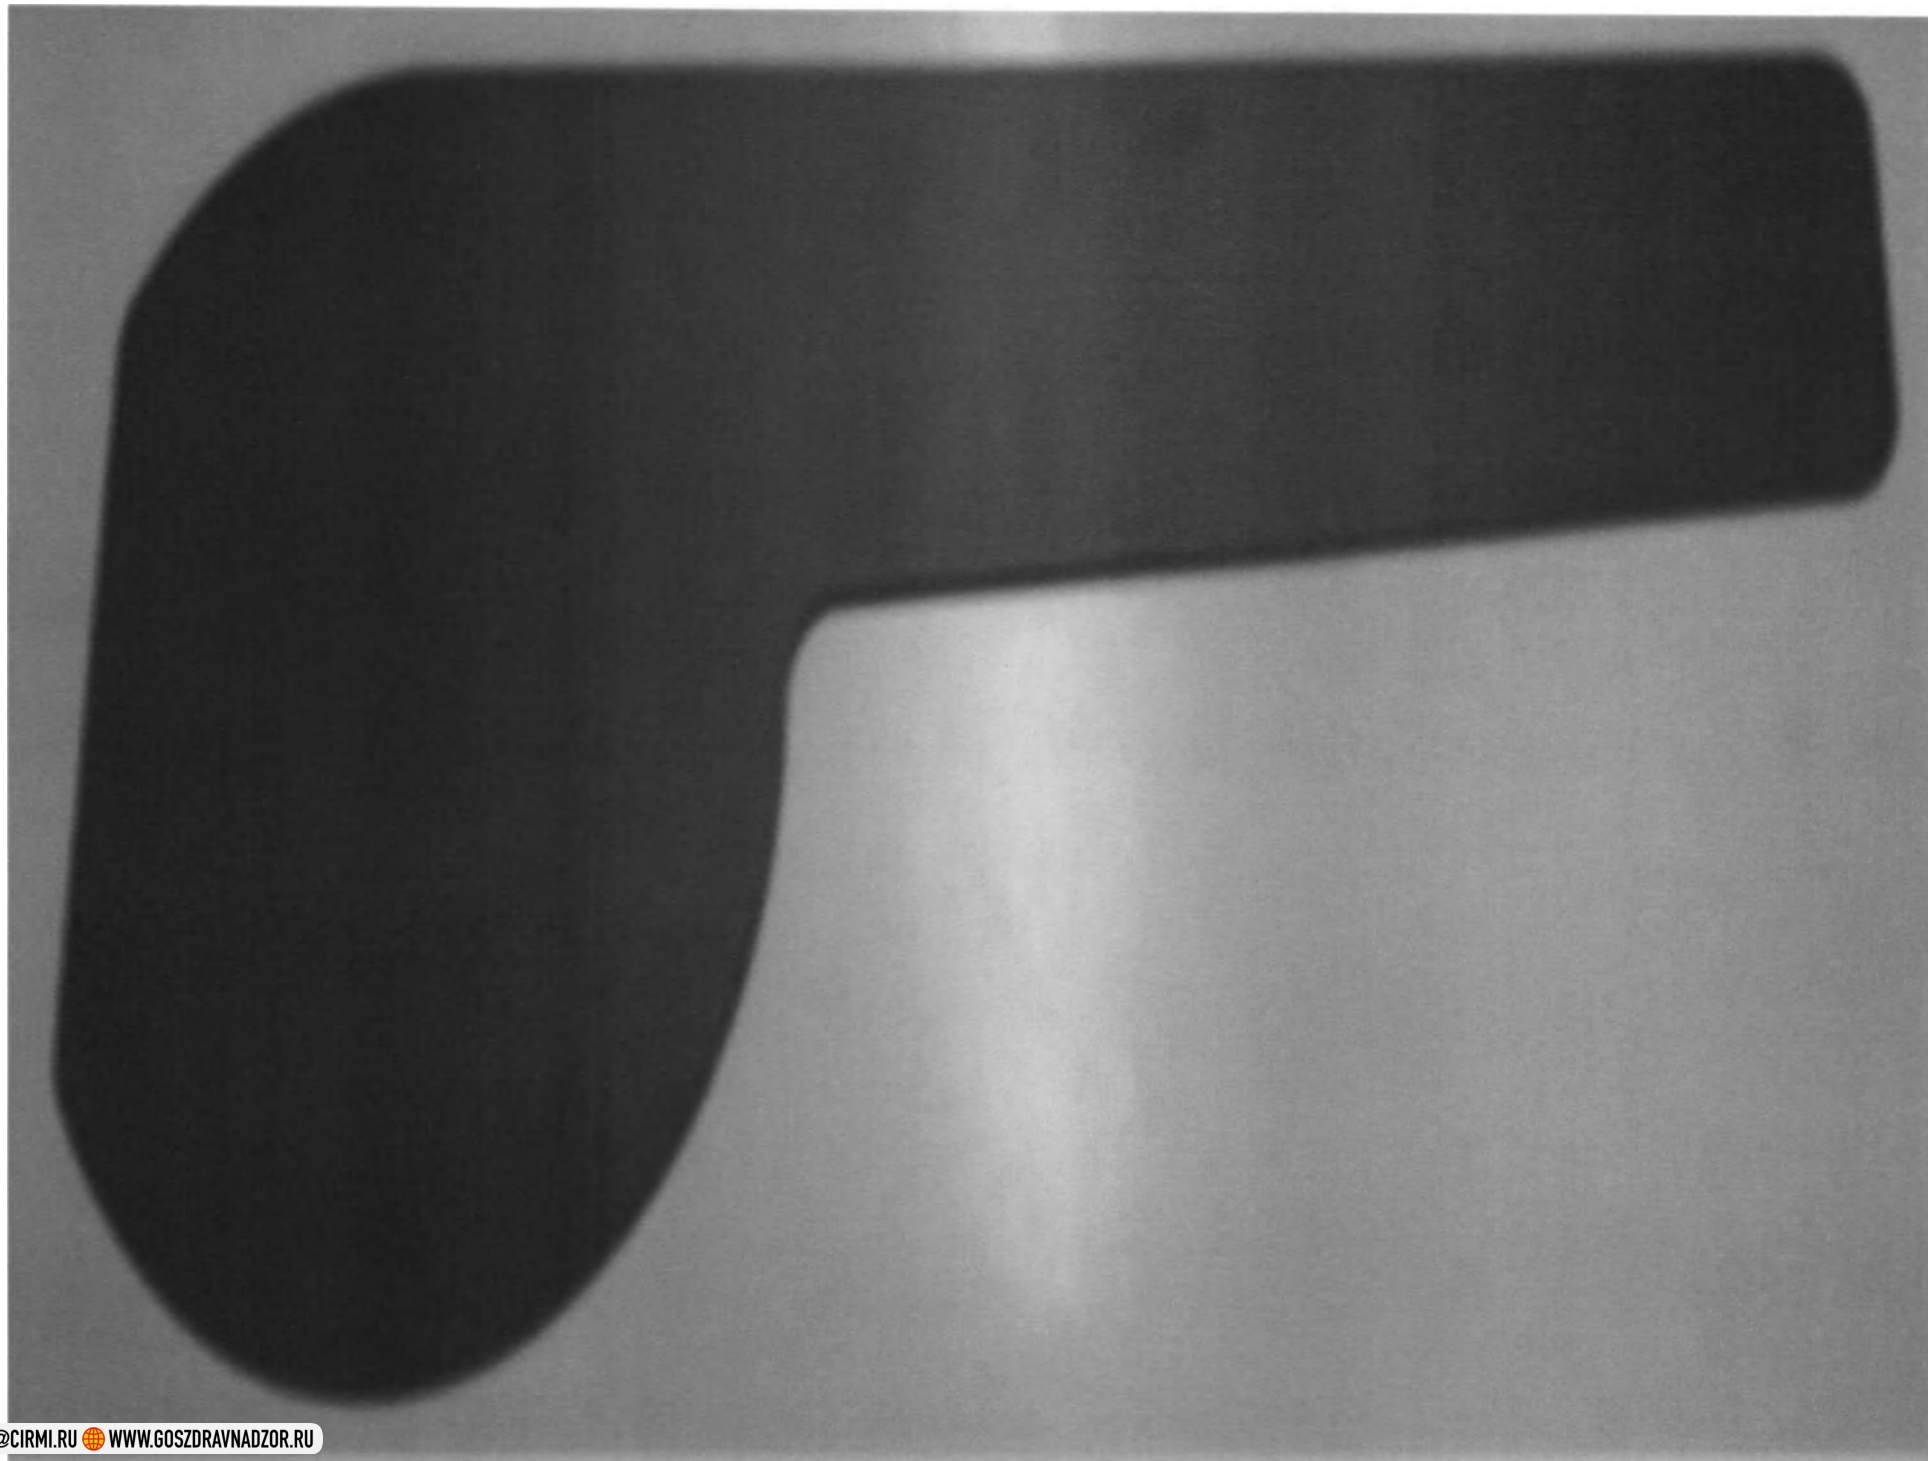

11. Держатель для рук (для САТ-850В).




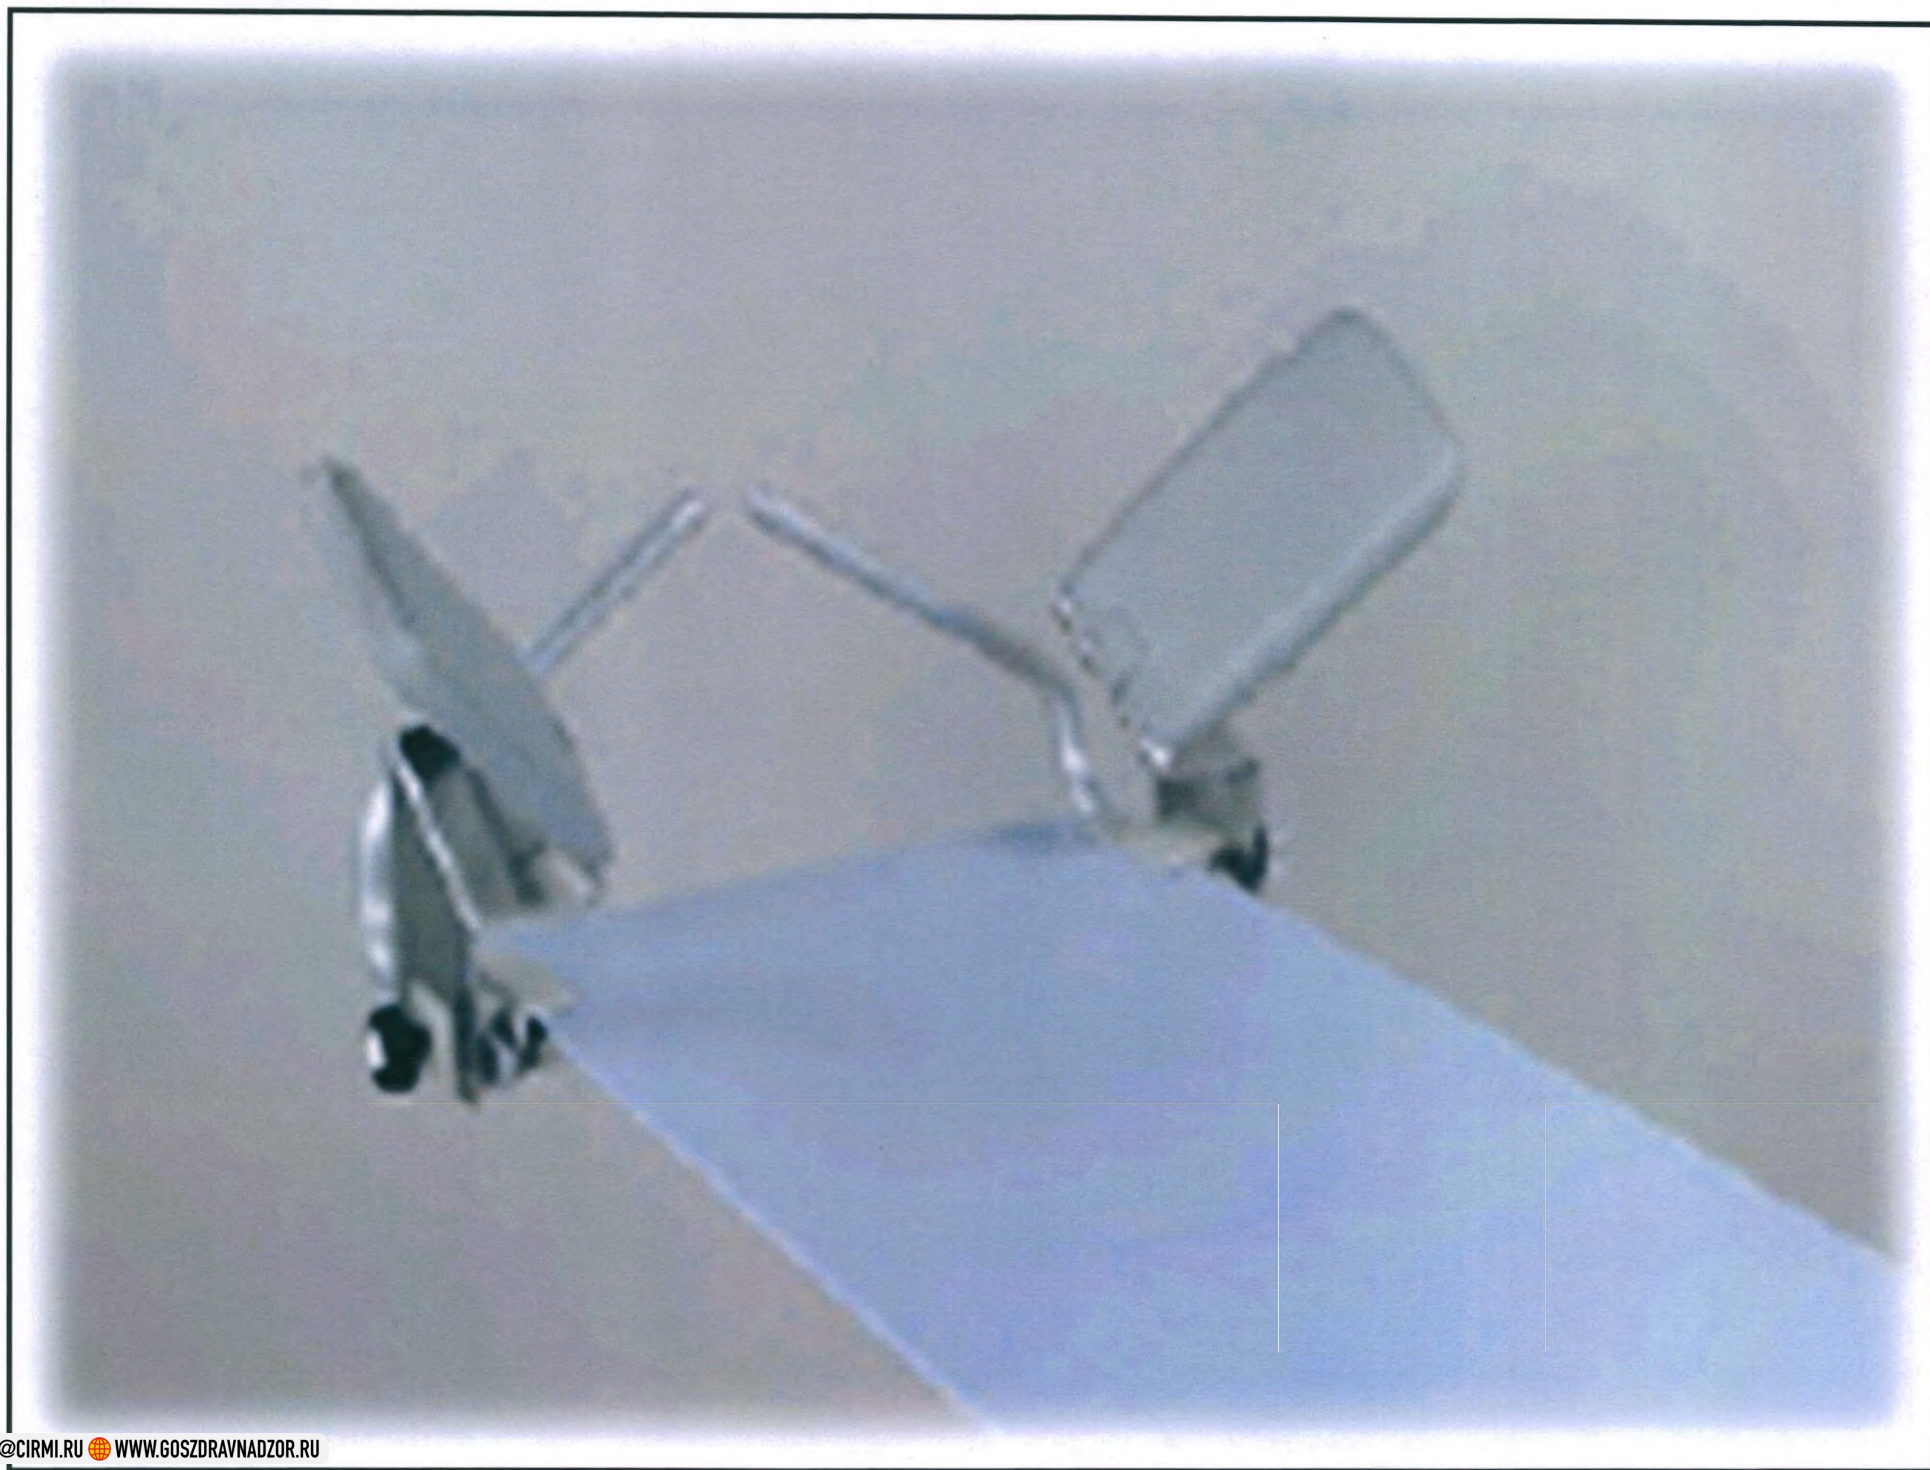


13. Нарукавник (панель для защиты рук).





14. Дополнительная направляющая деки стола (для CAT-880B).

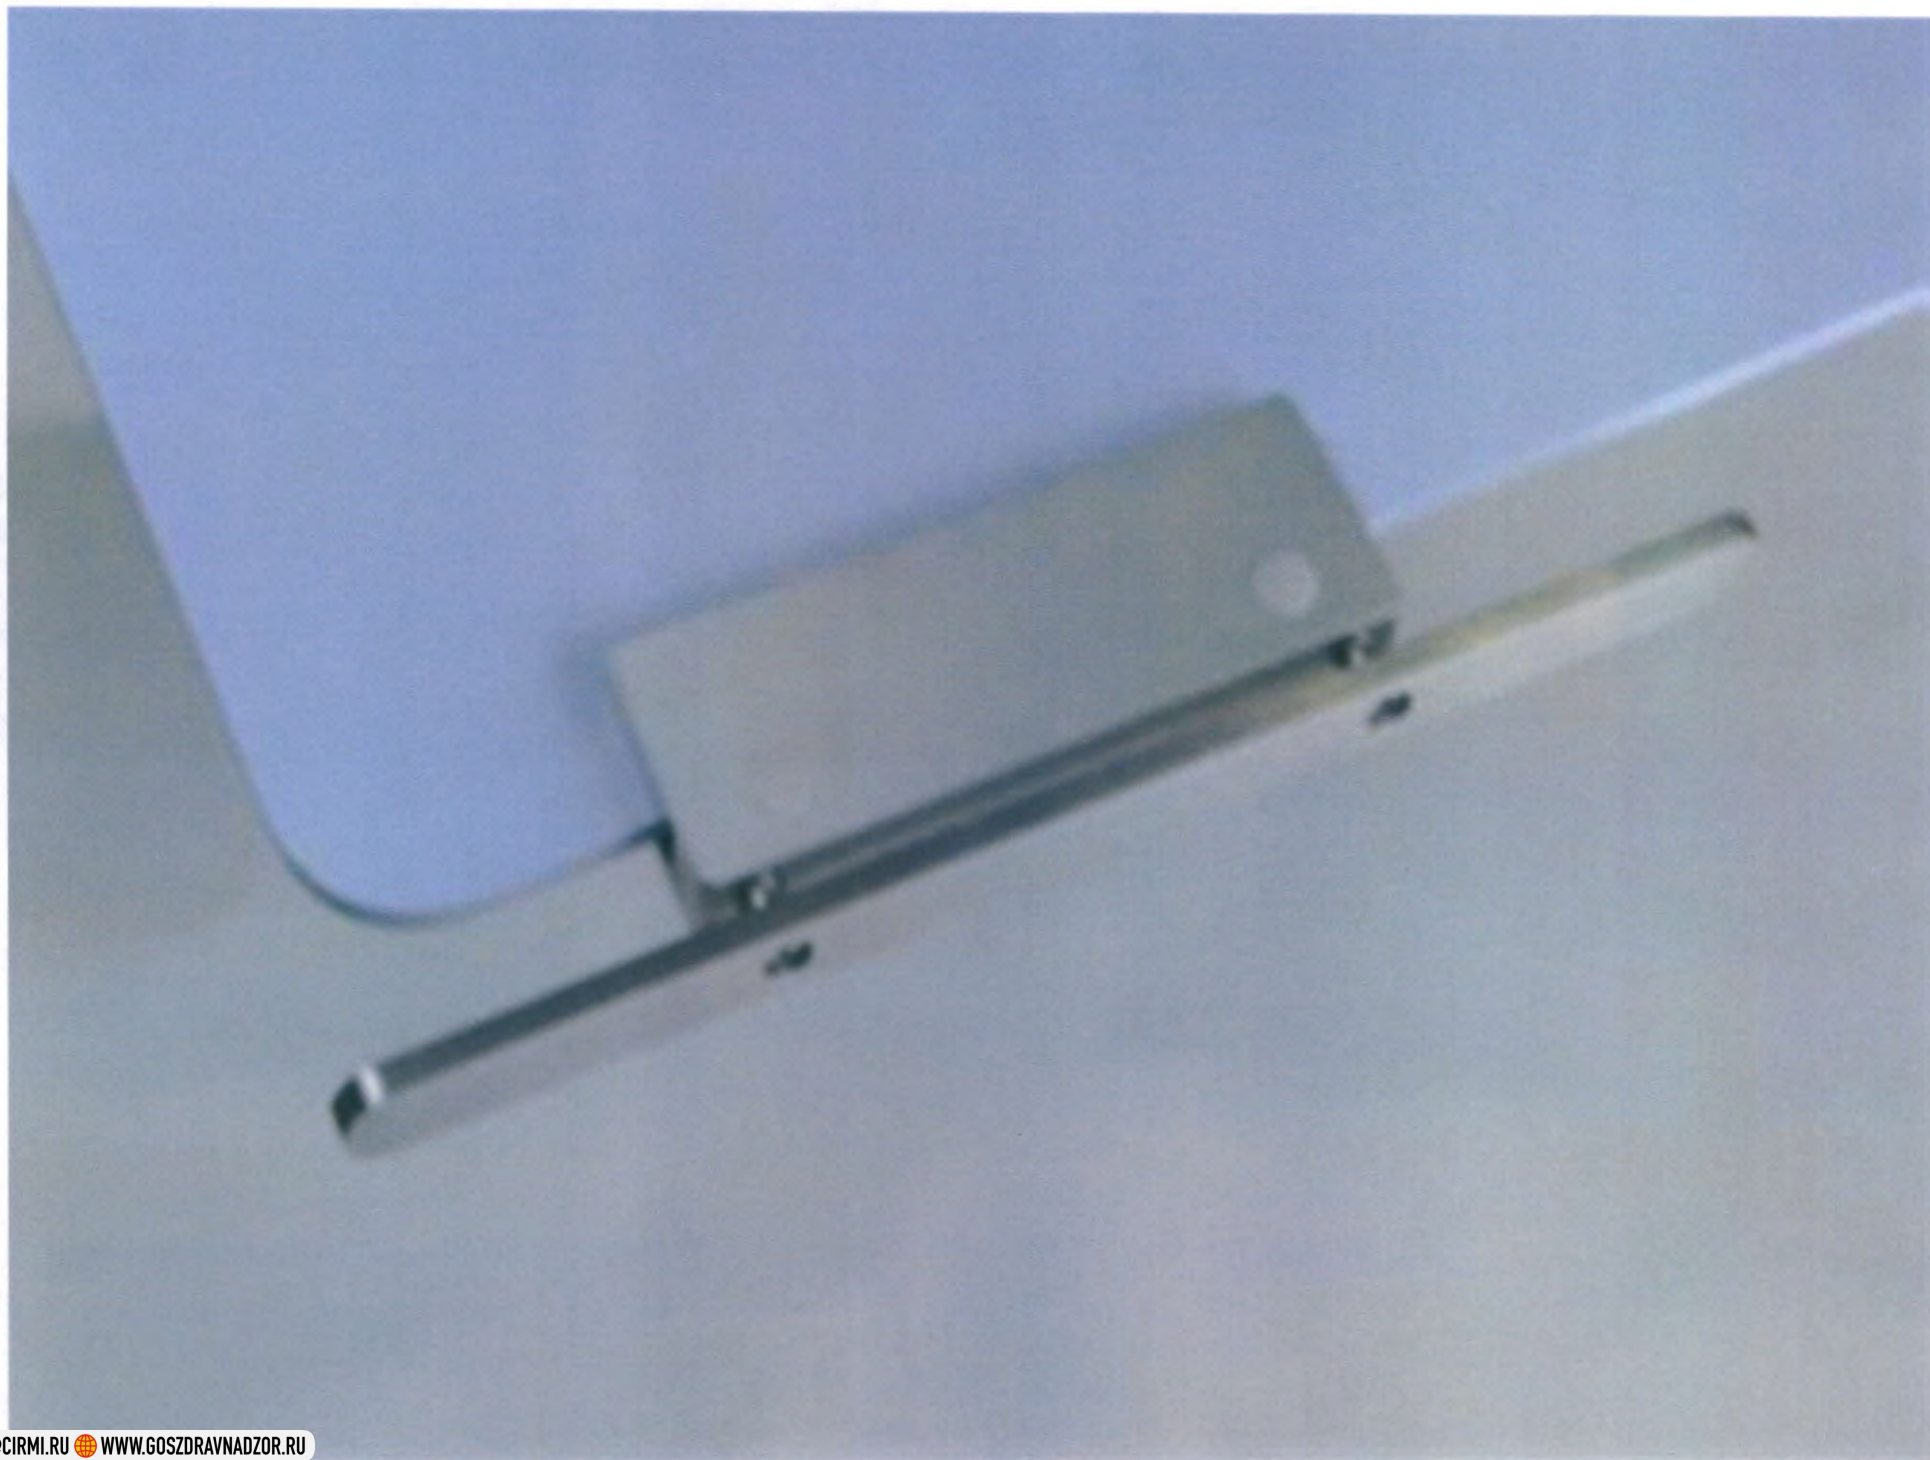

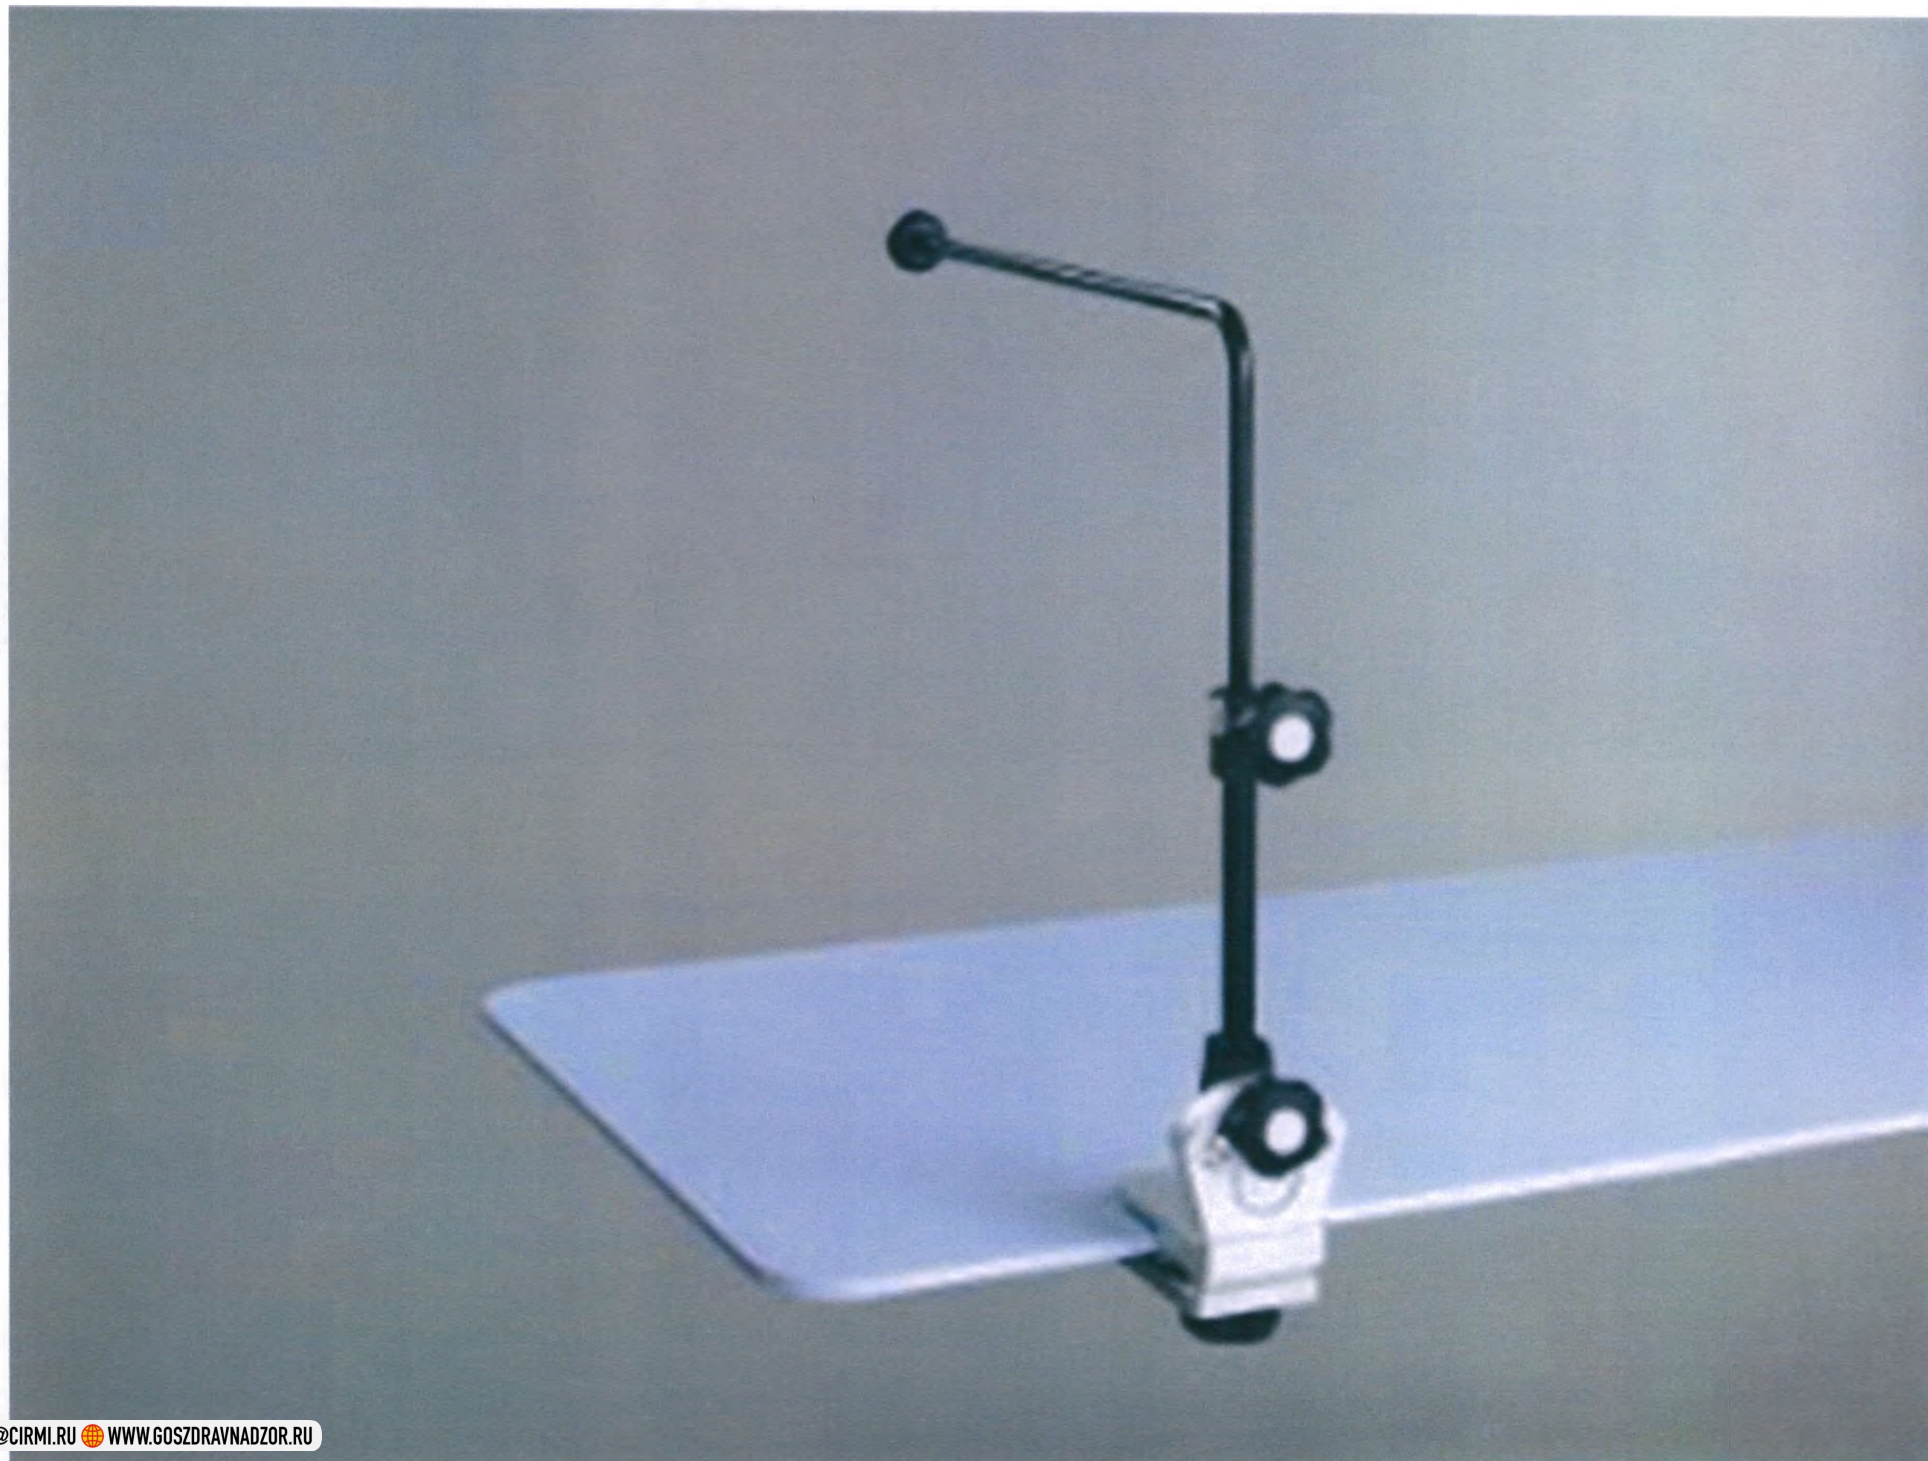



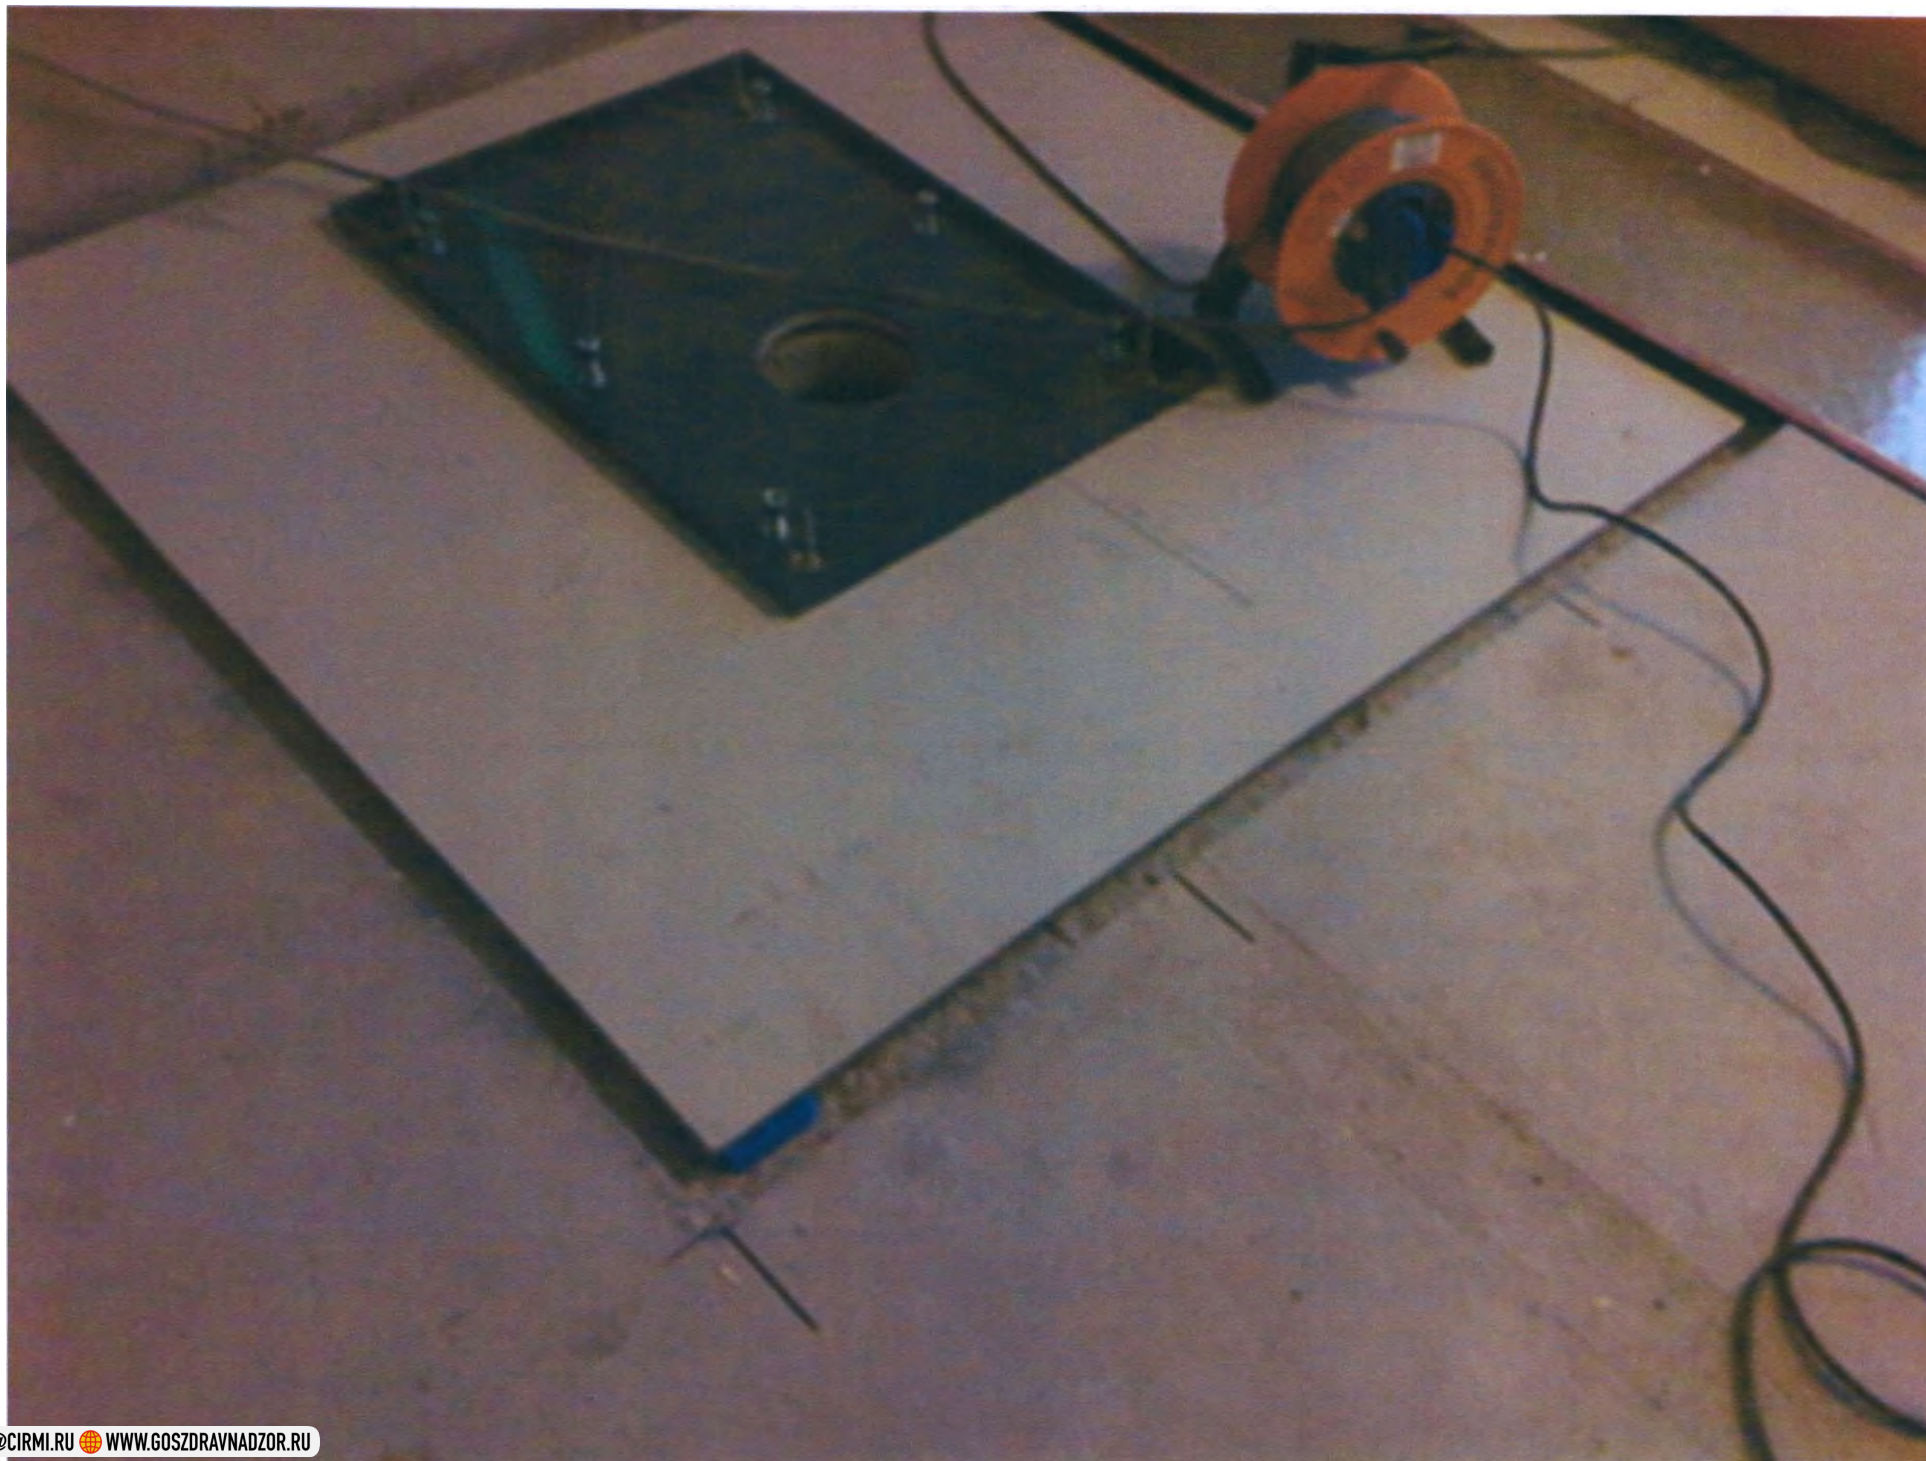

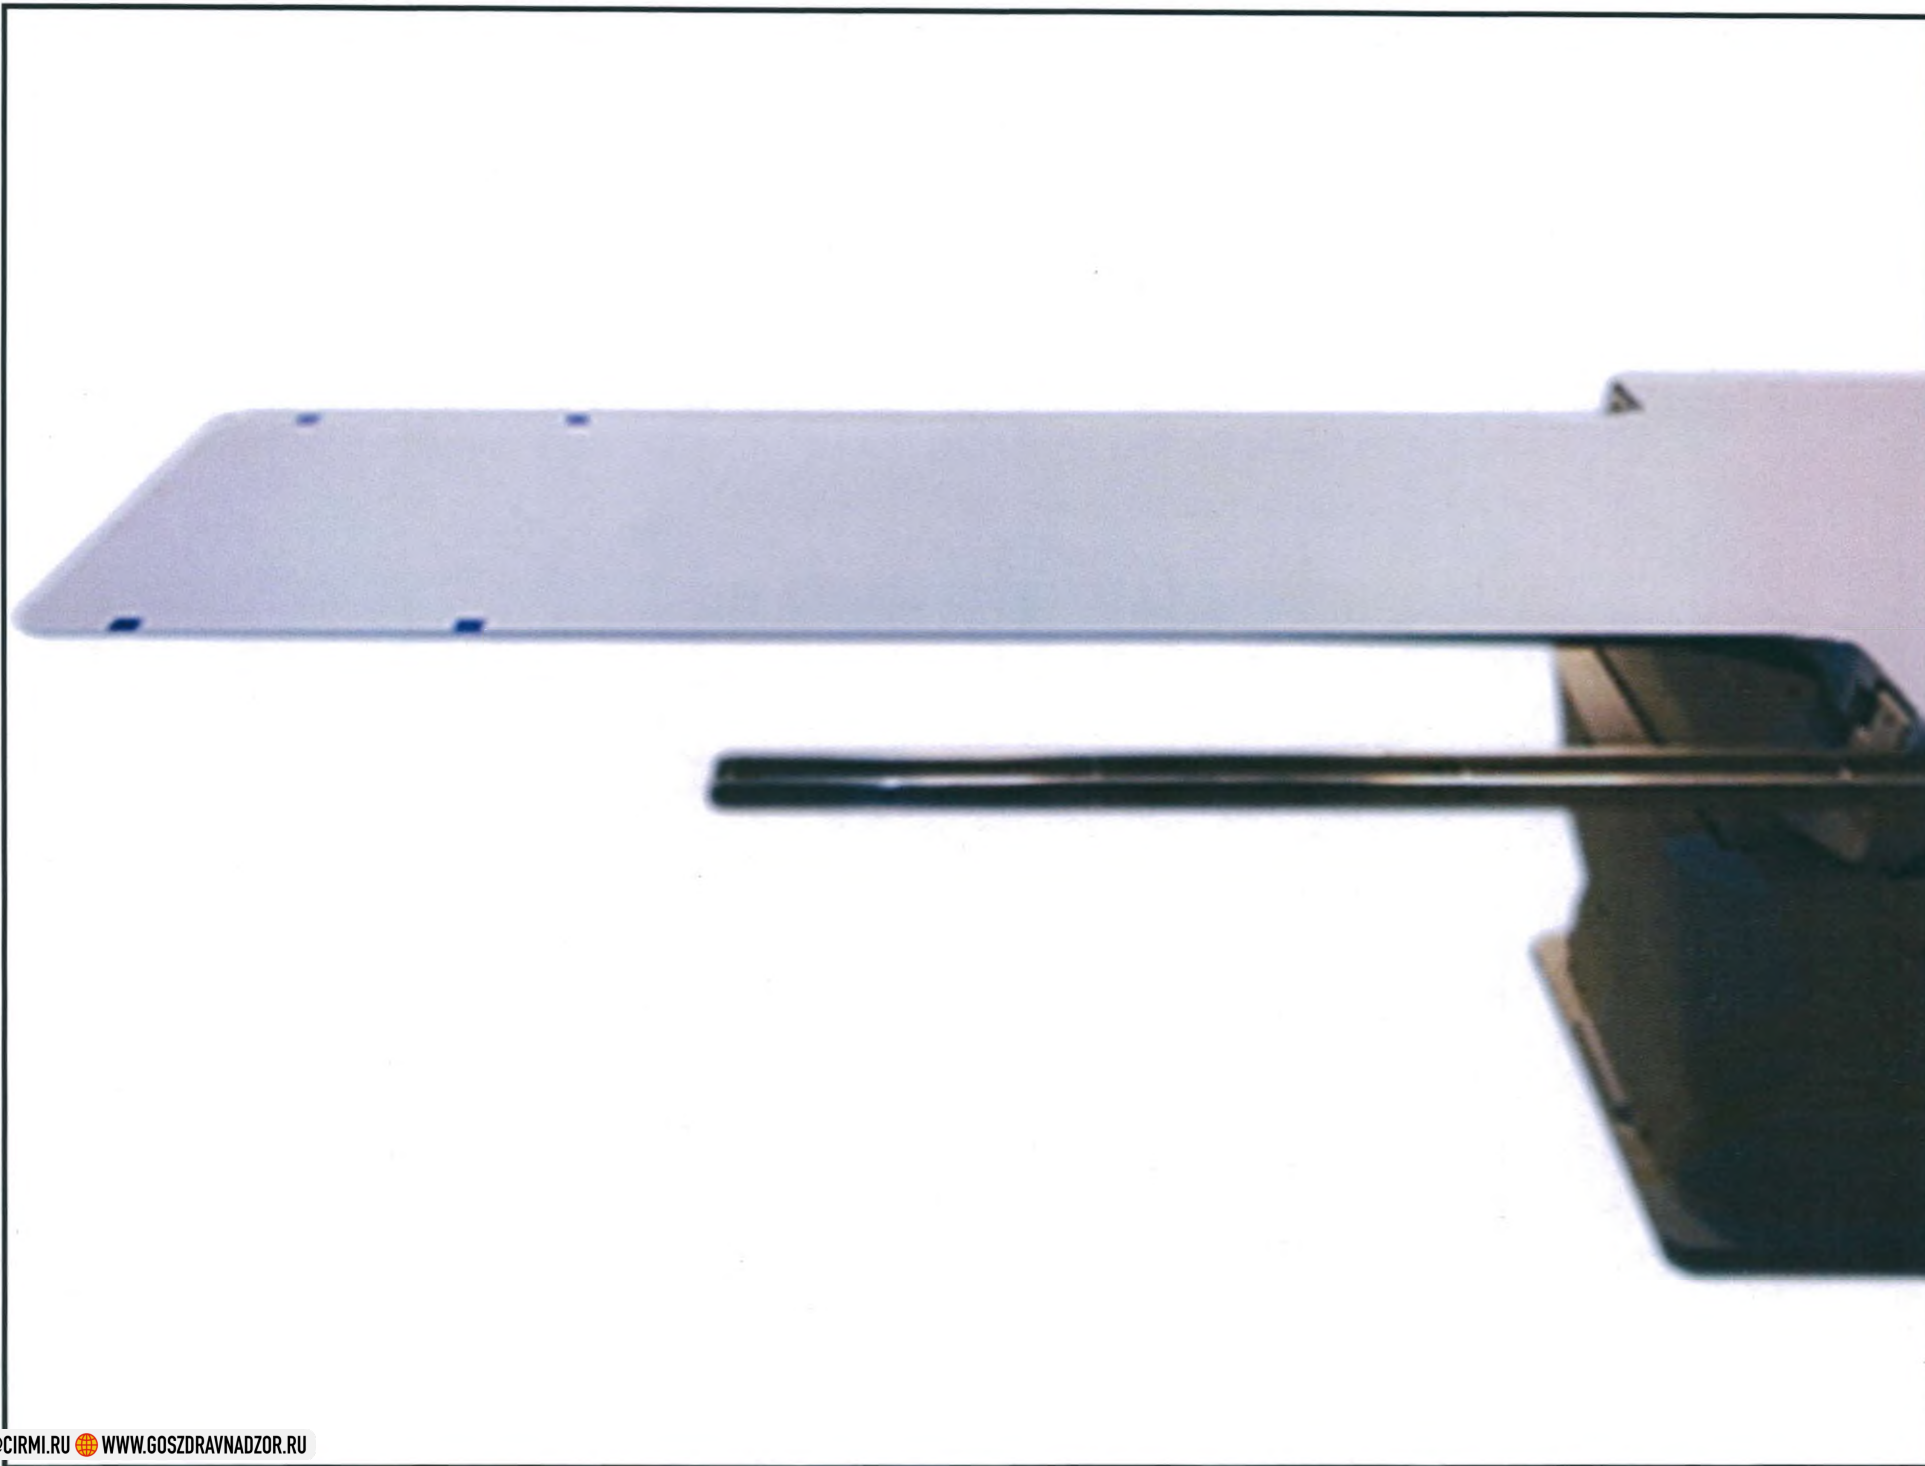




20. Комплект управляющего переключателя стола на головном конце (для CAT-850B).






22. Боковая планшетная консоль стола.




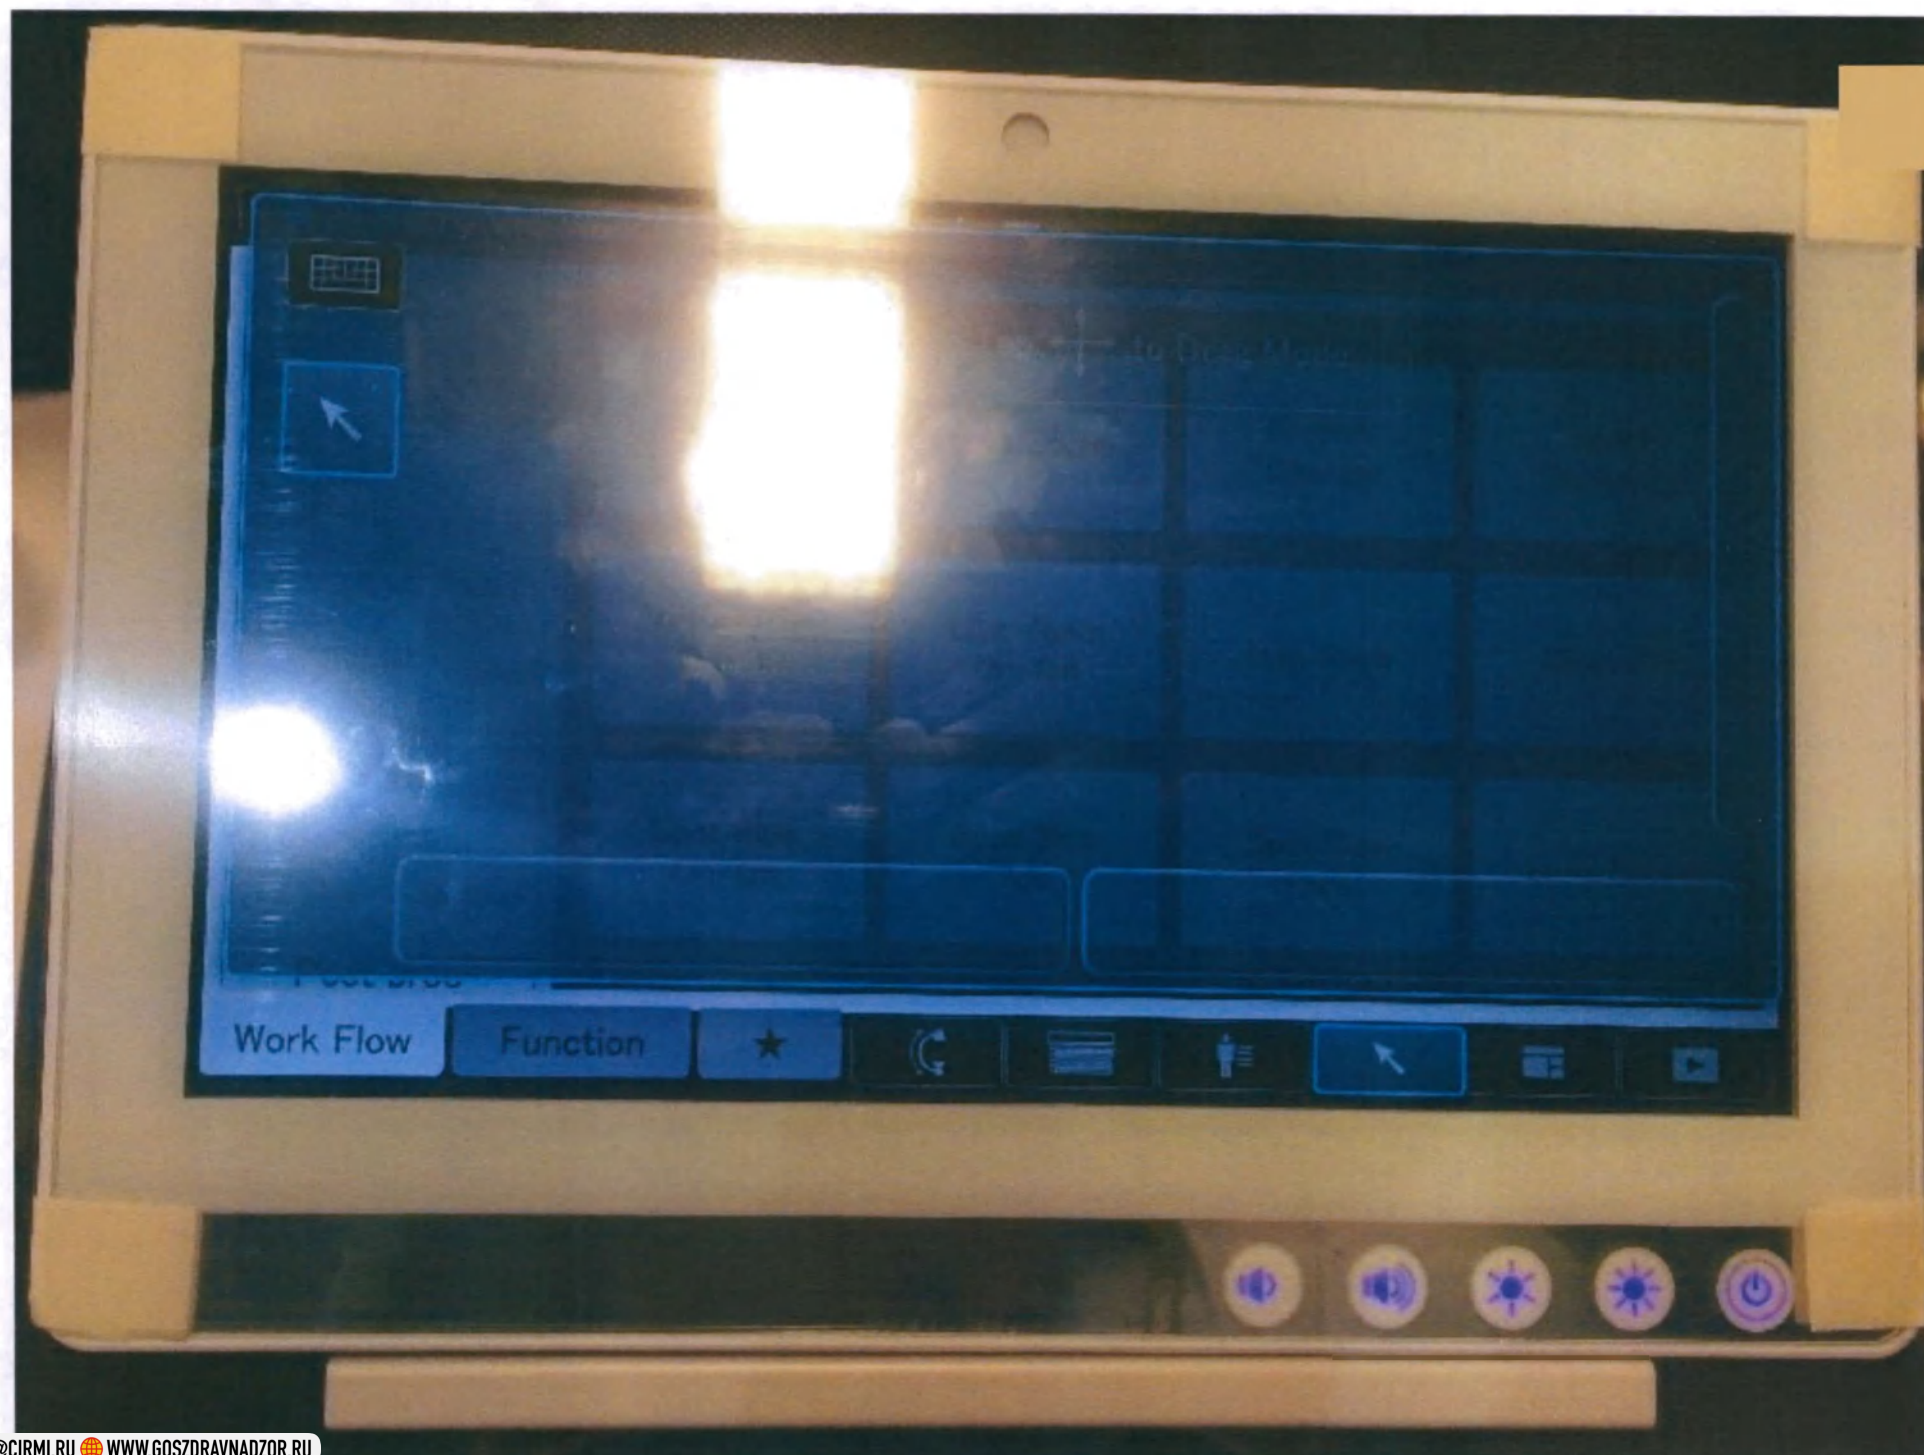


23. Вспомогательная планшетная консоль (Подставка для планшетной консоли).

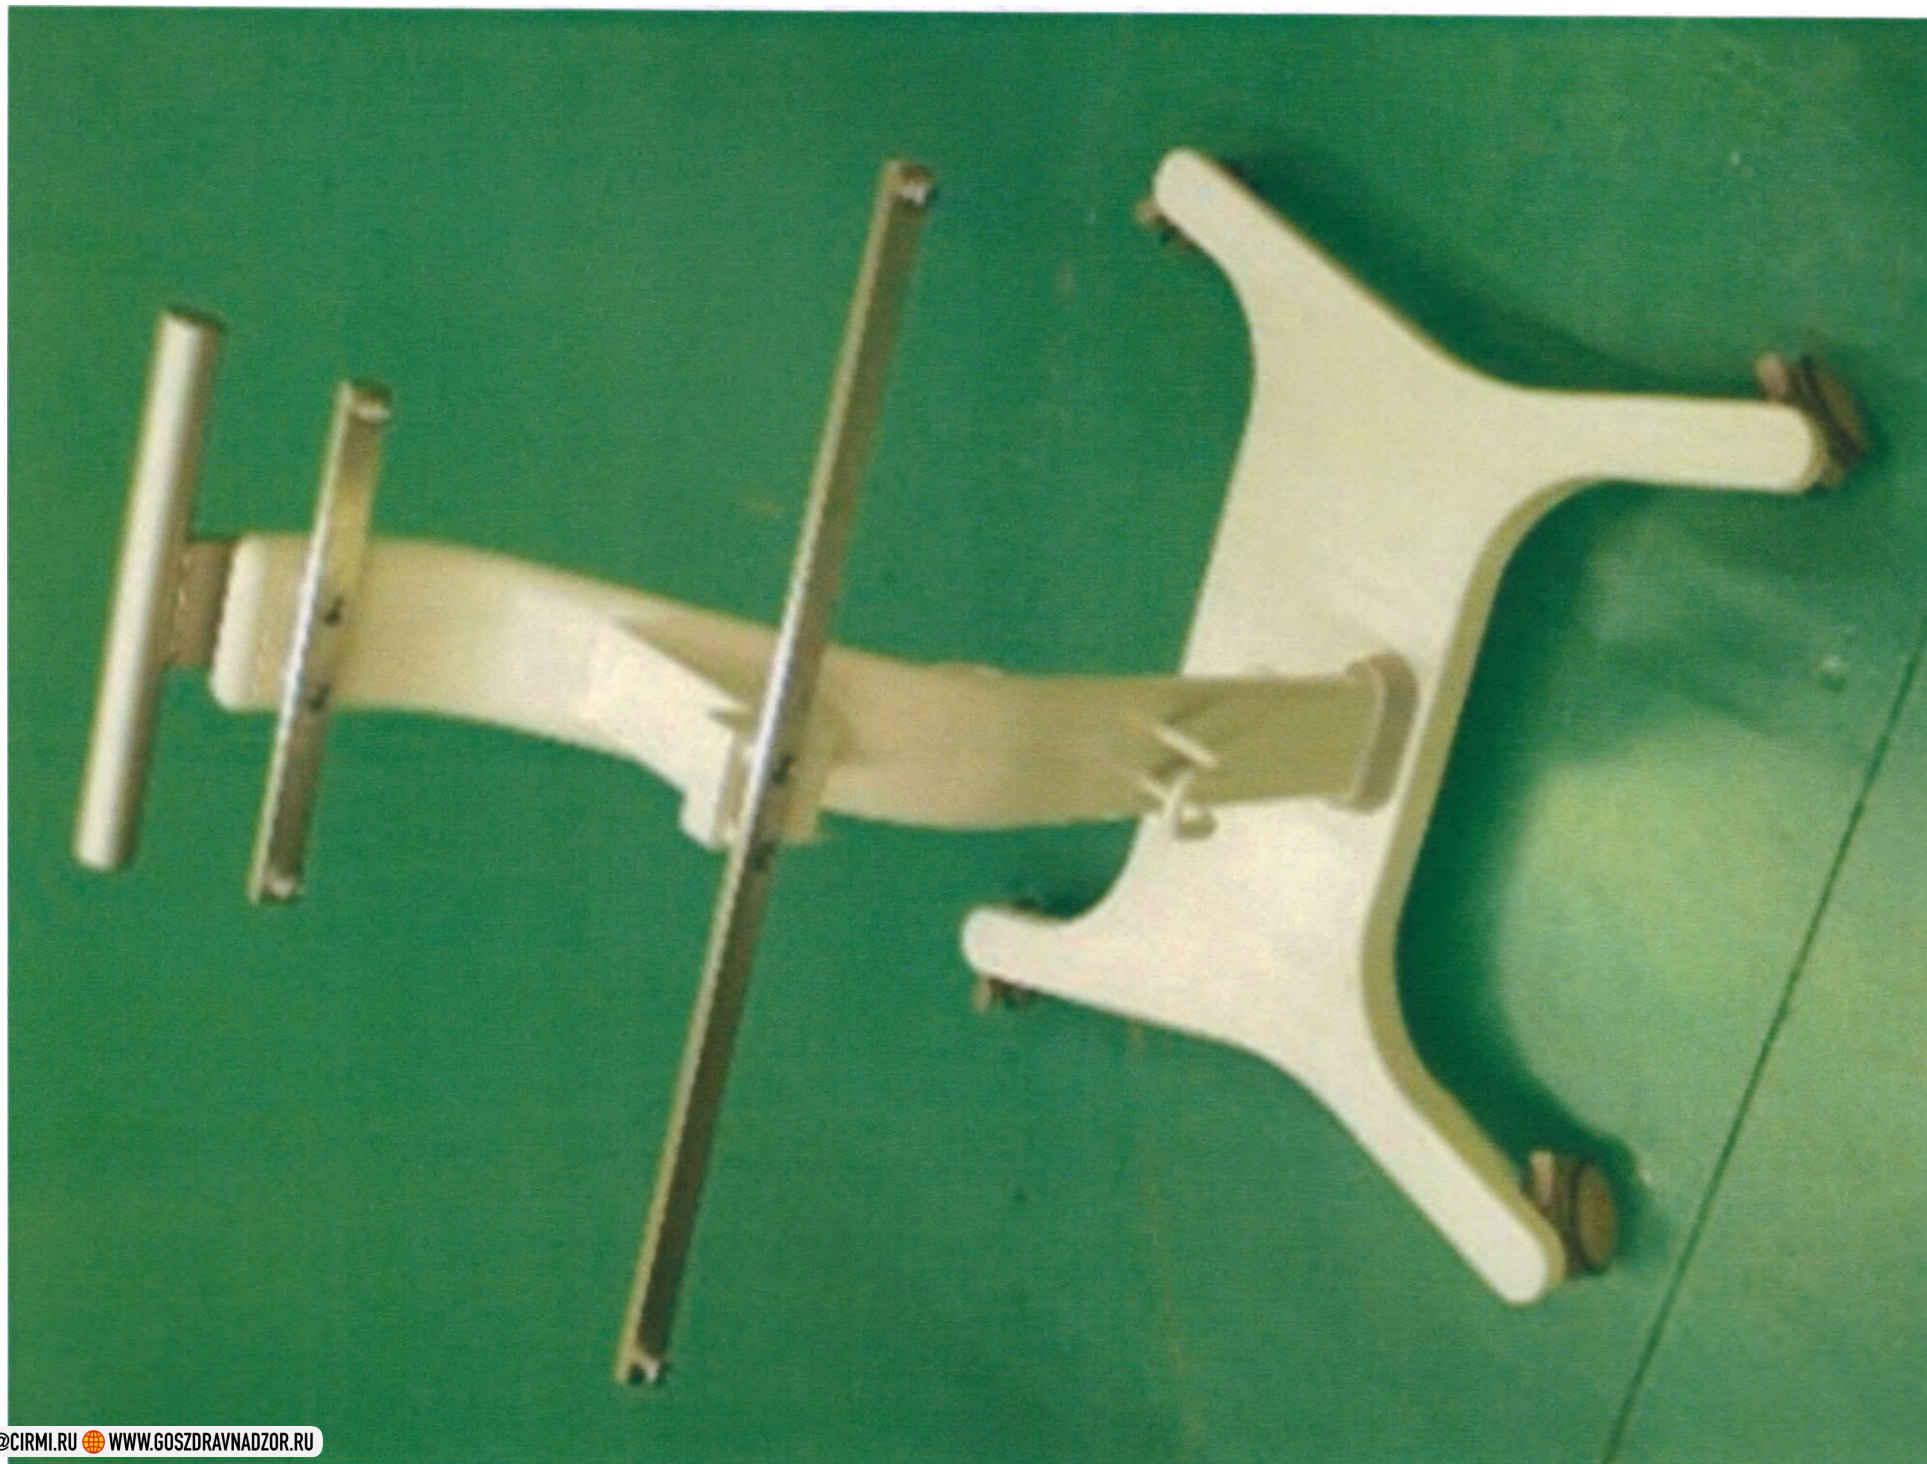



24. Боковая планшетная консоль стола с блоком переключателей.

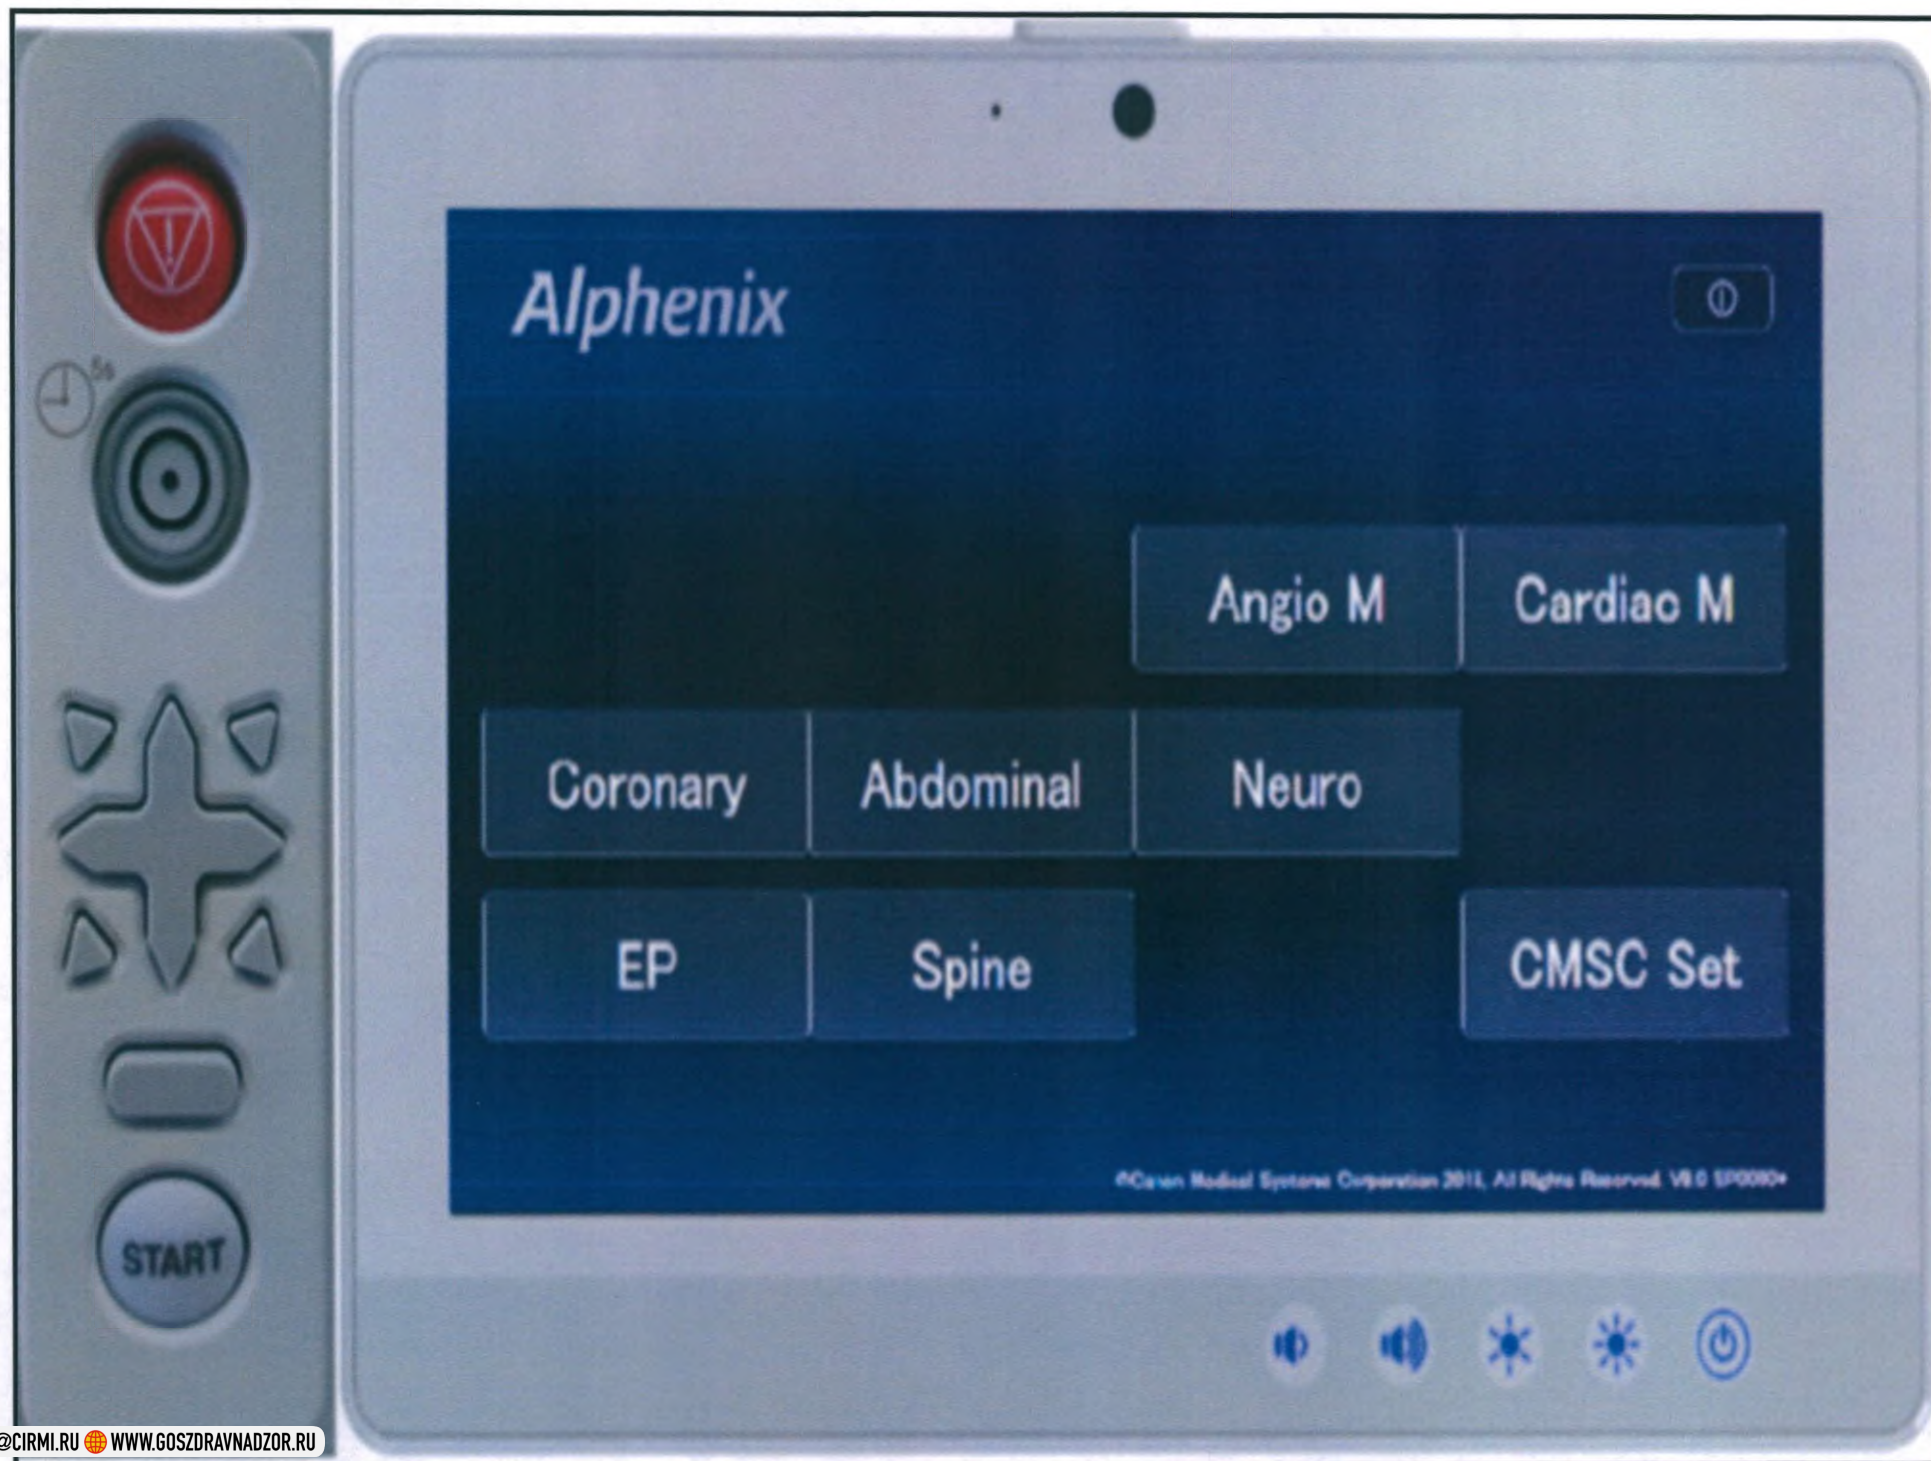

25. Вспомогательная планшетная консоль с блоком переключателей.

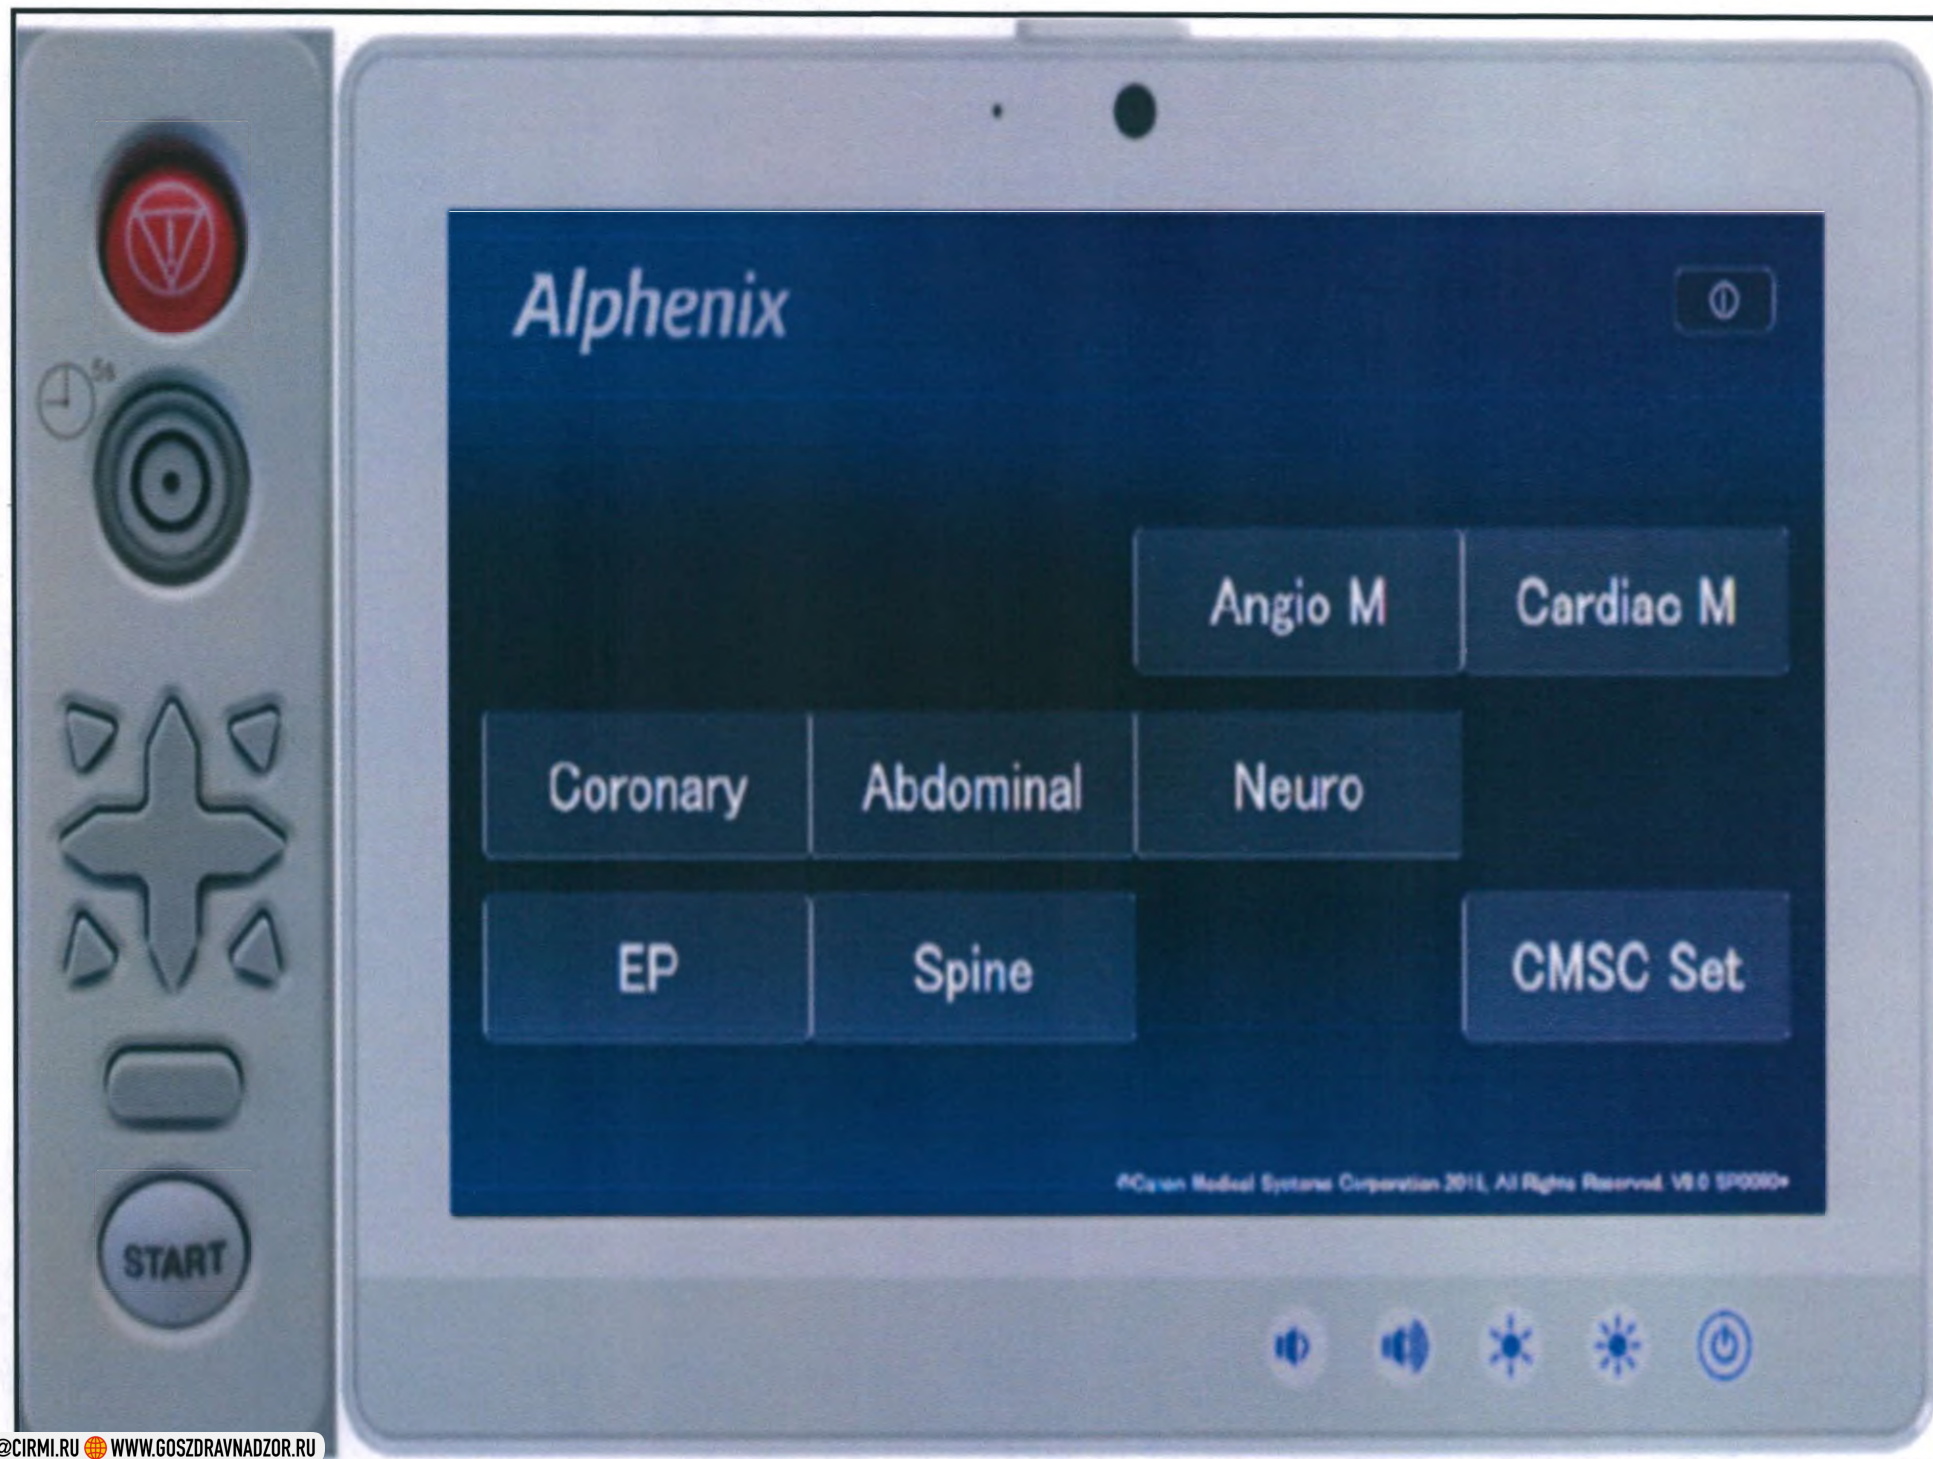

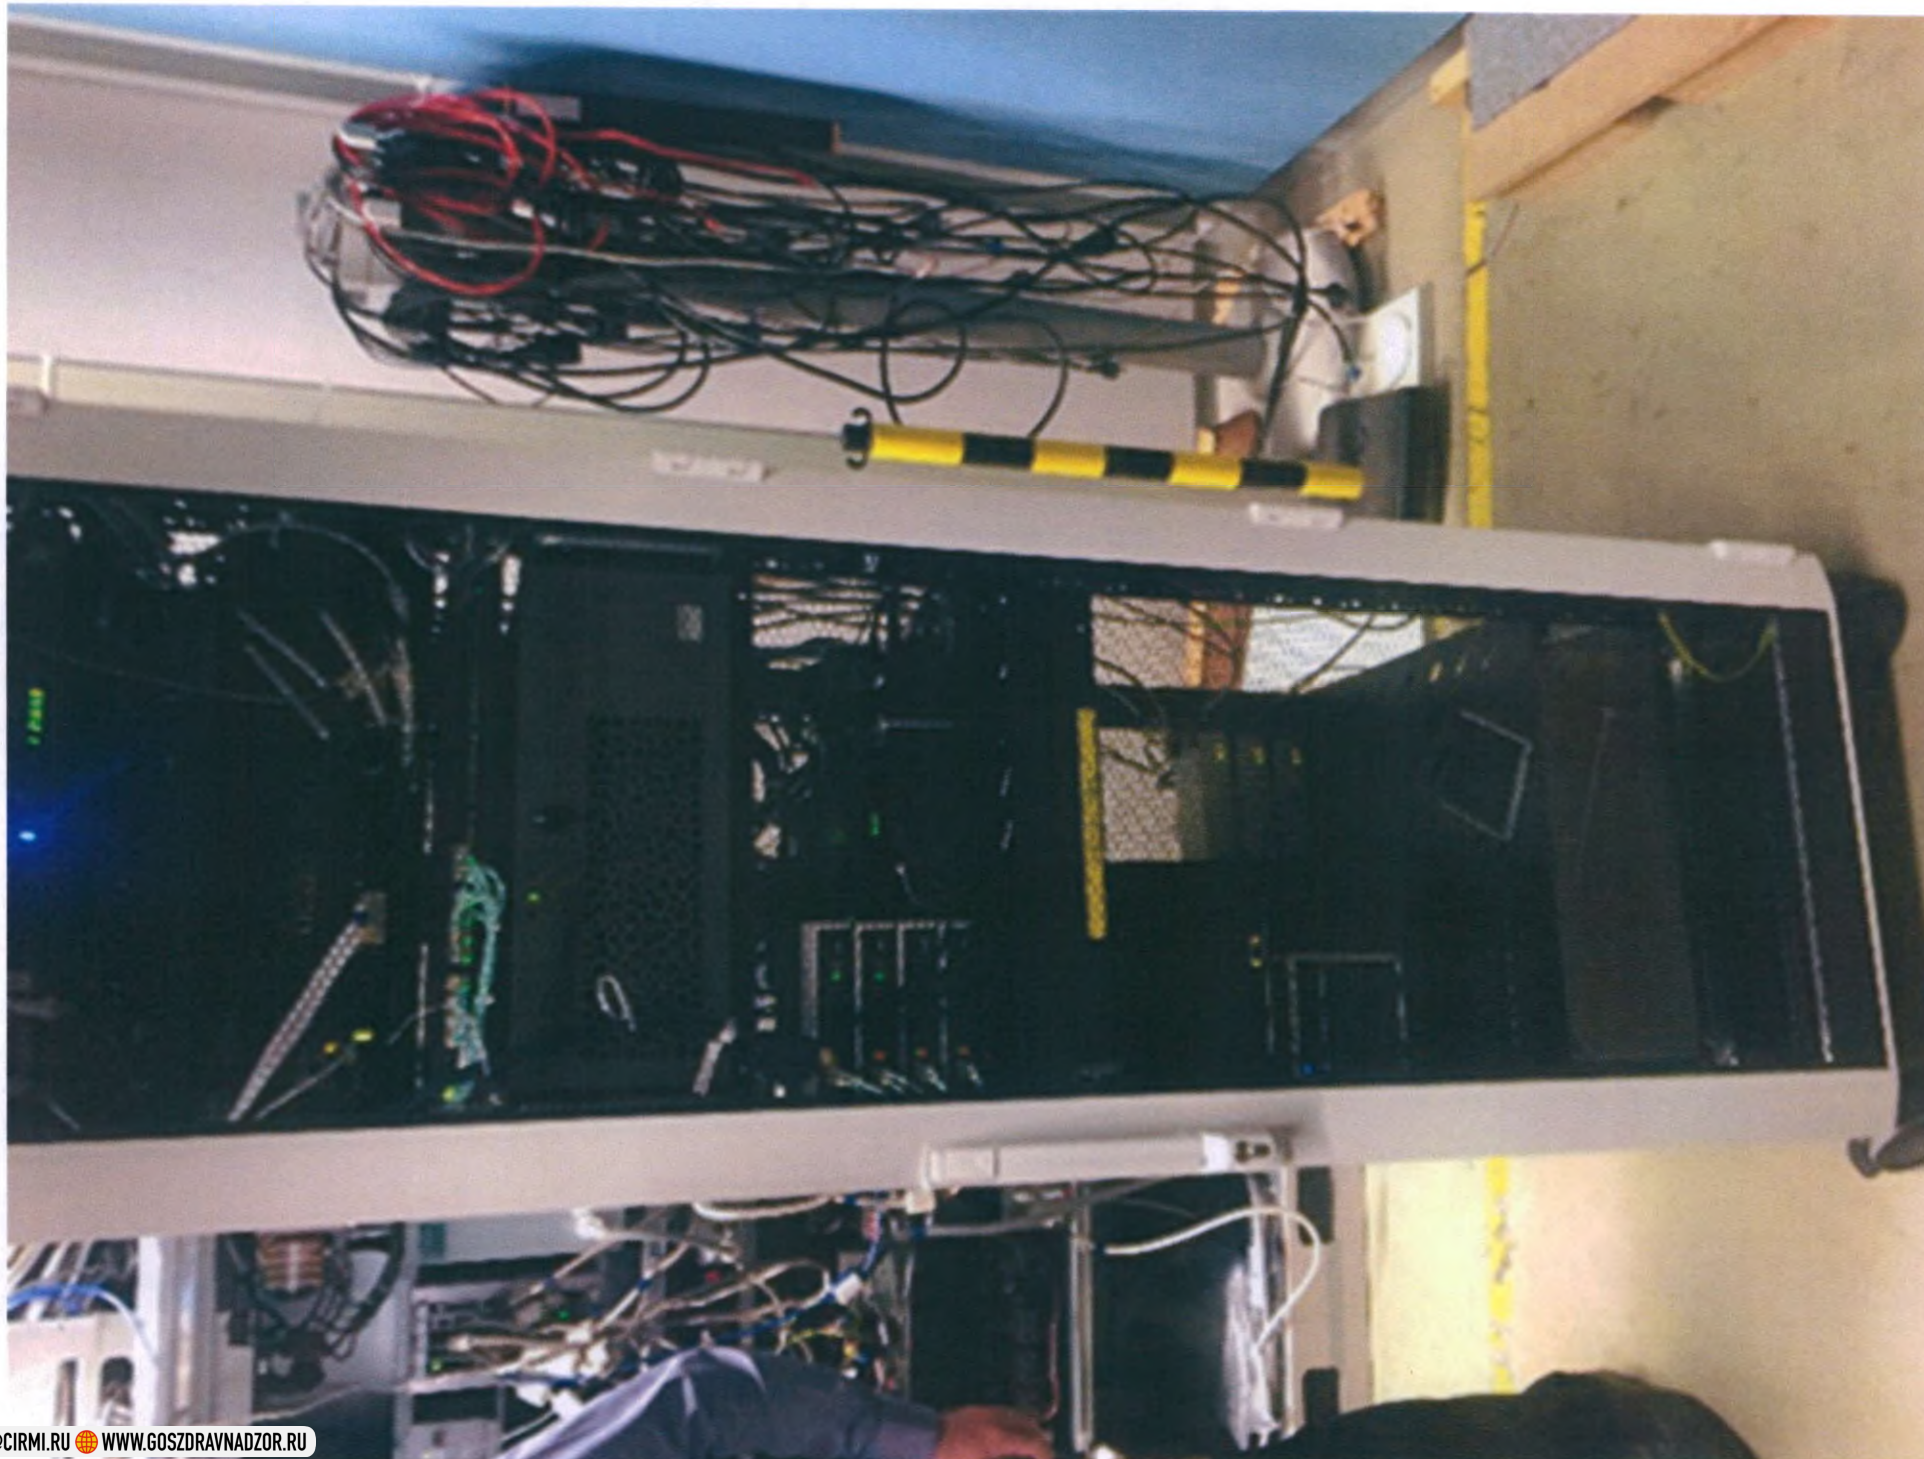

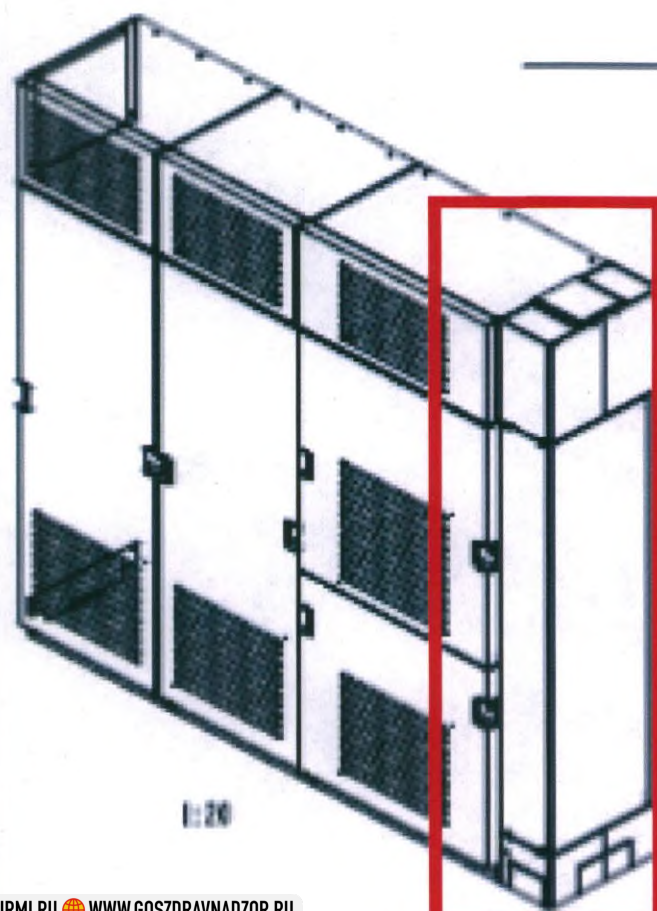




29. Комплект принадлежностей для ступенчатой ЦСА.




Шаговое устройство
встроено внутрь
CAT-850B/B1

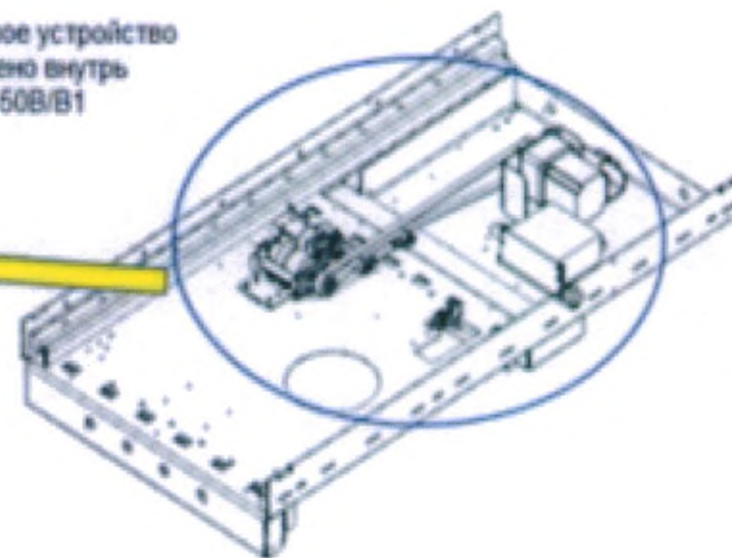




31. Модуль ротационной ЦСА.




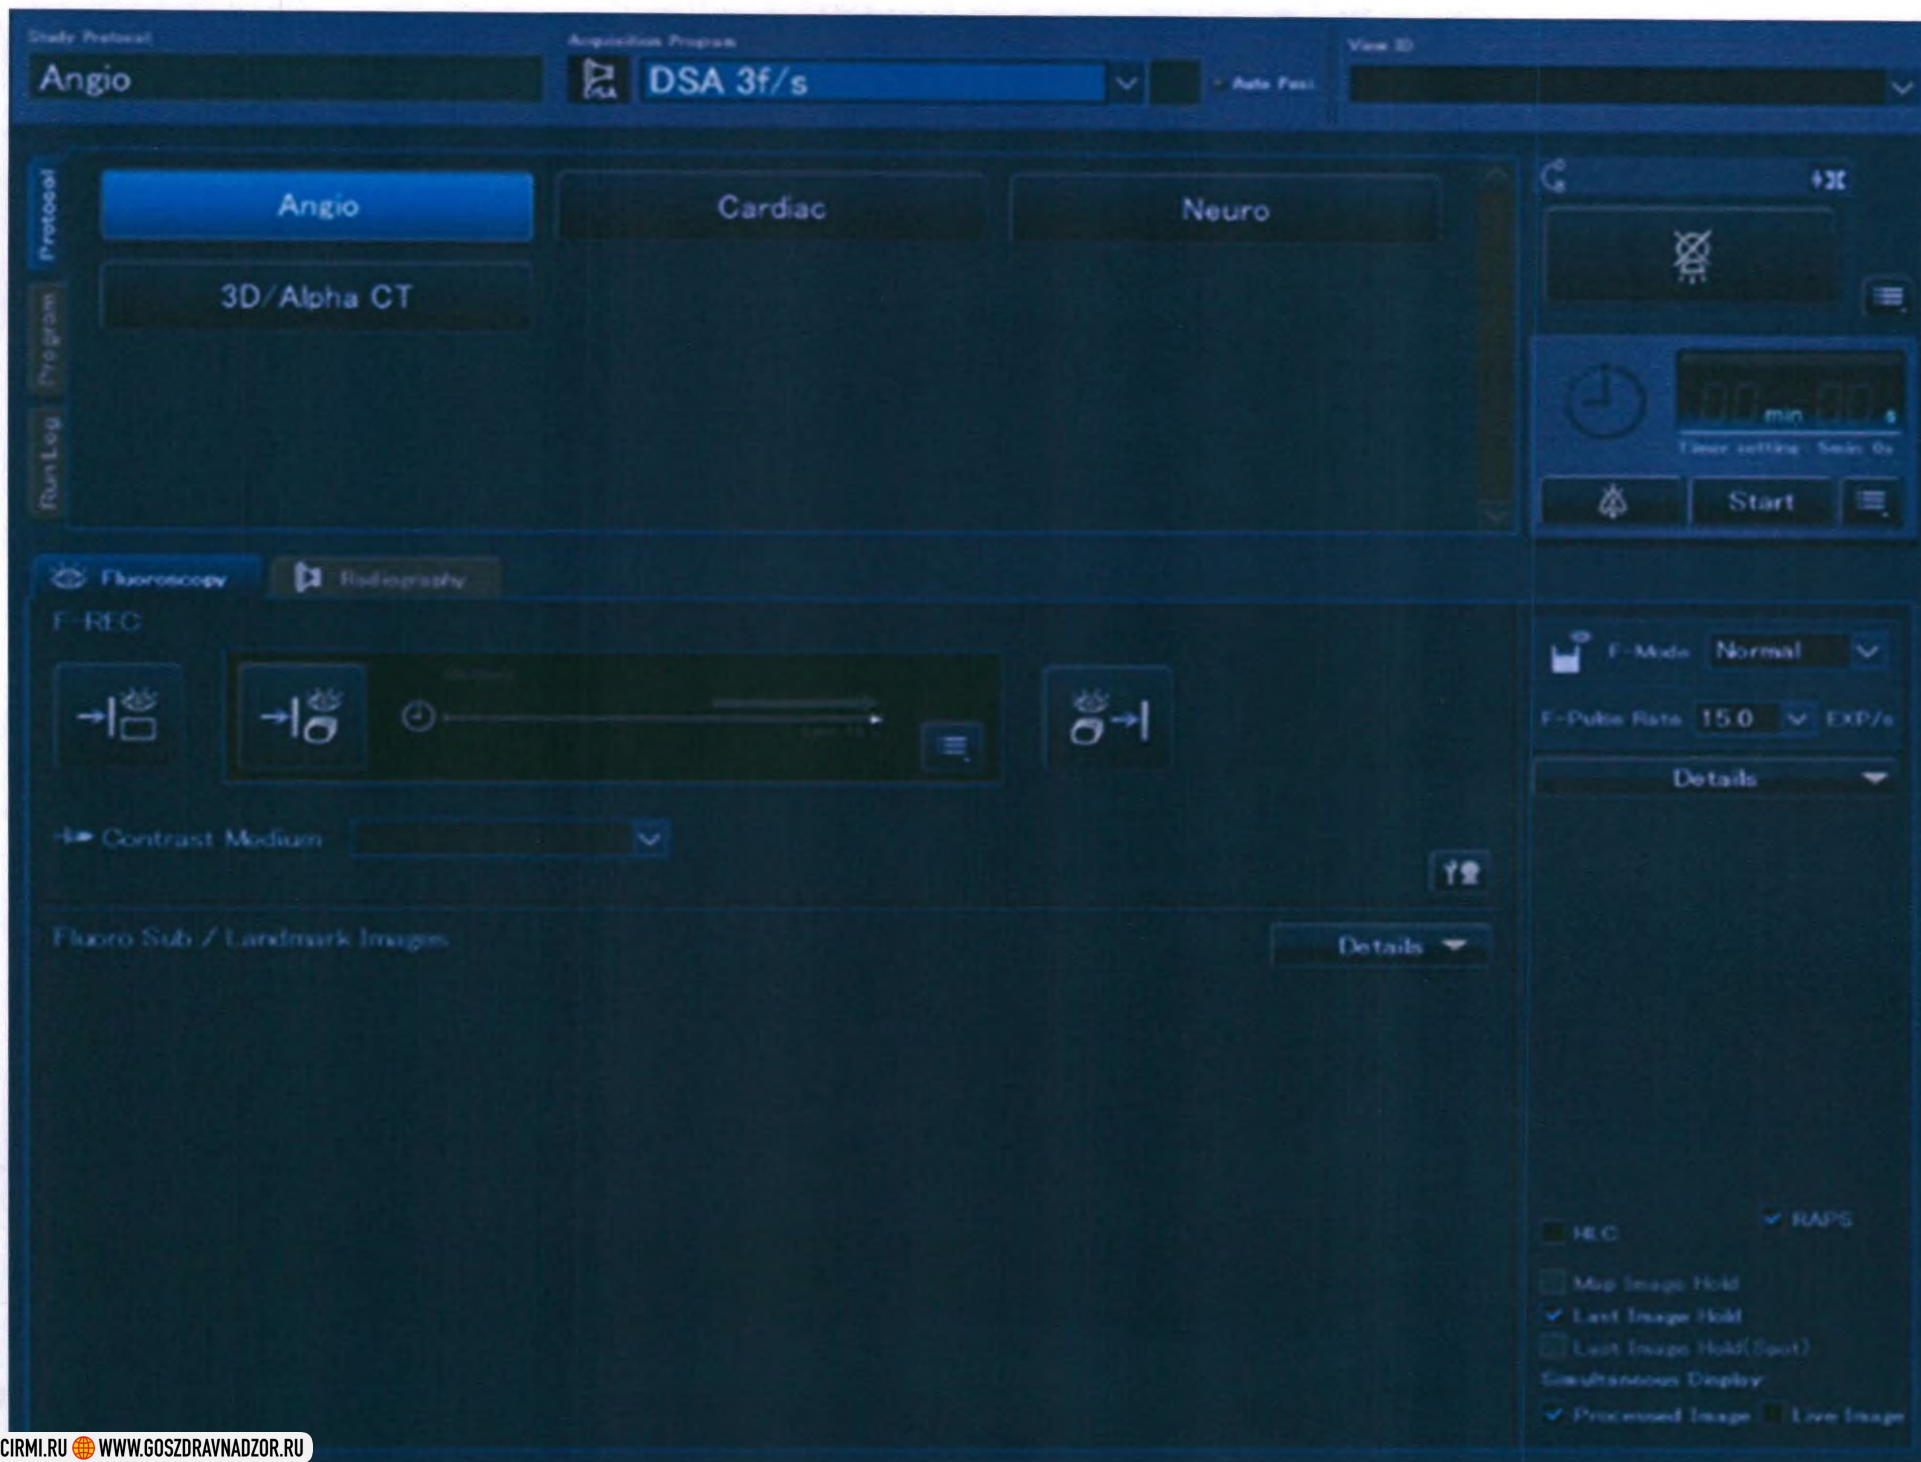

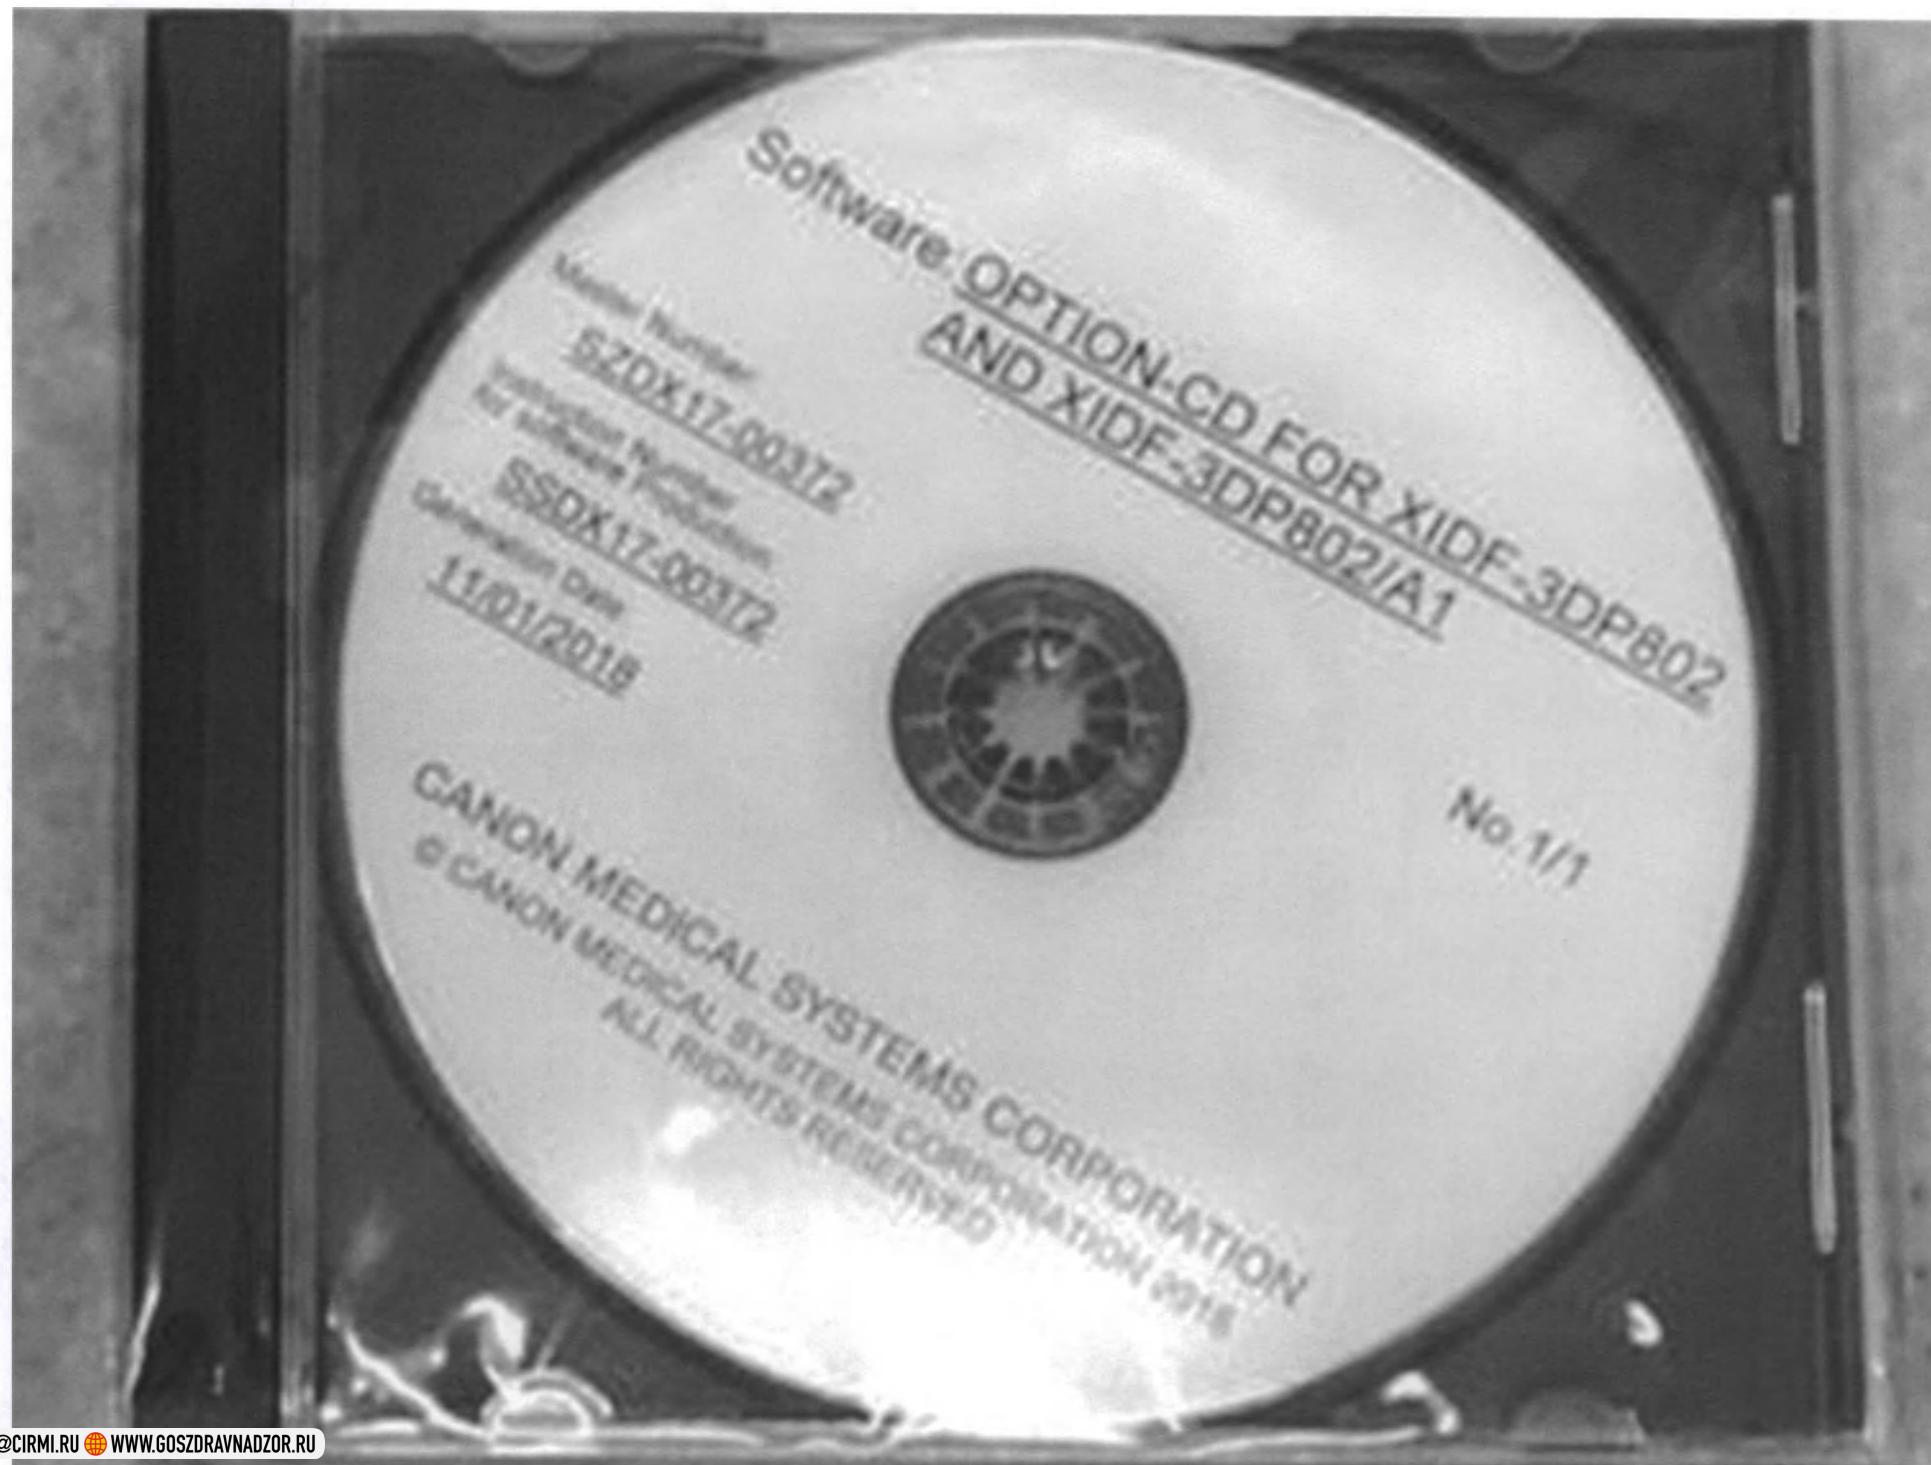


34. Комплект для вывода внешнего сигнала.



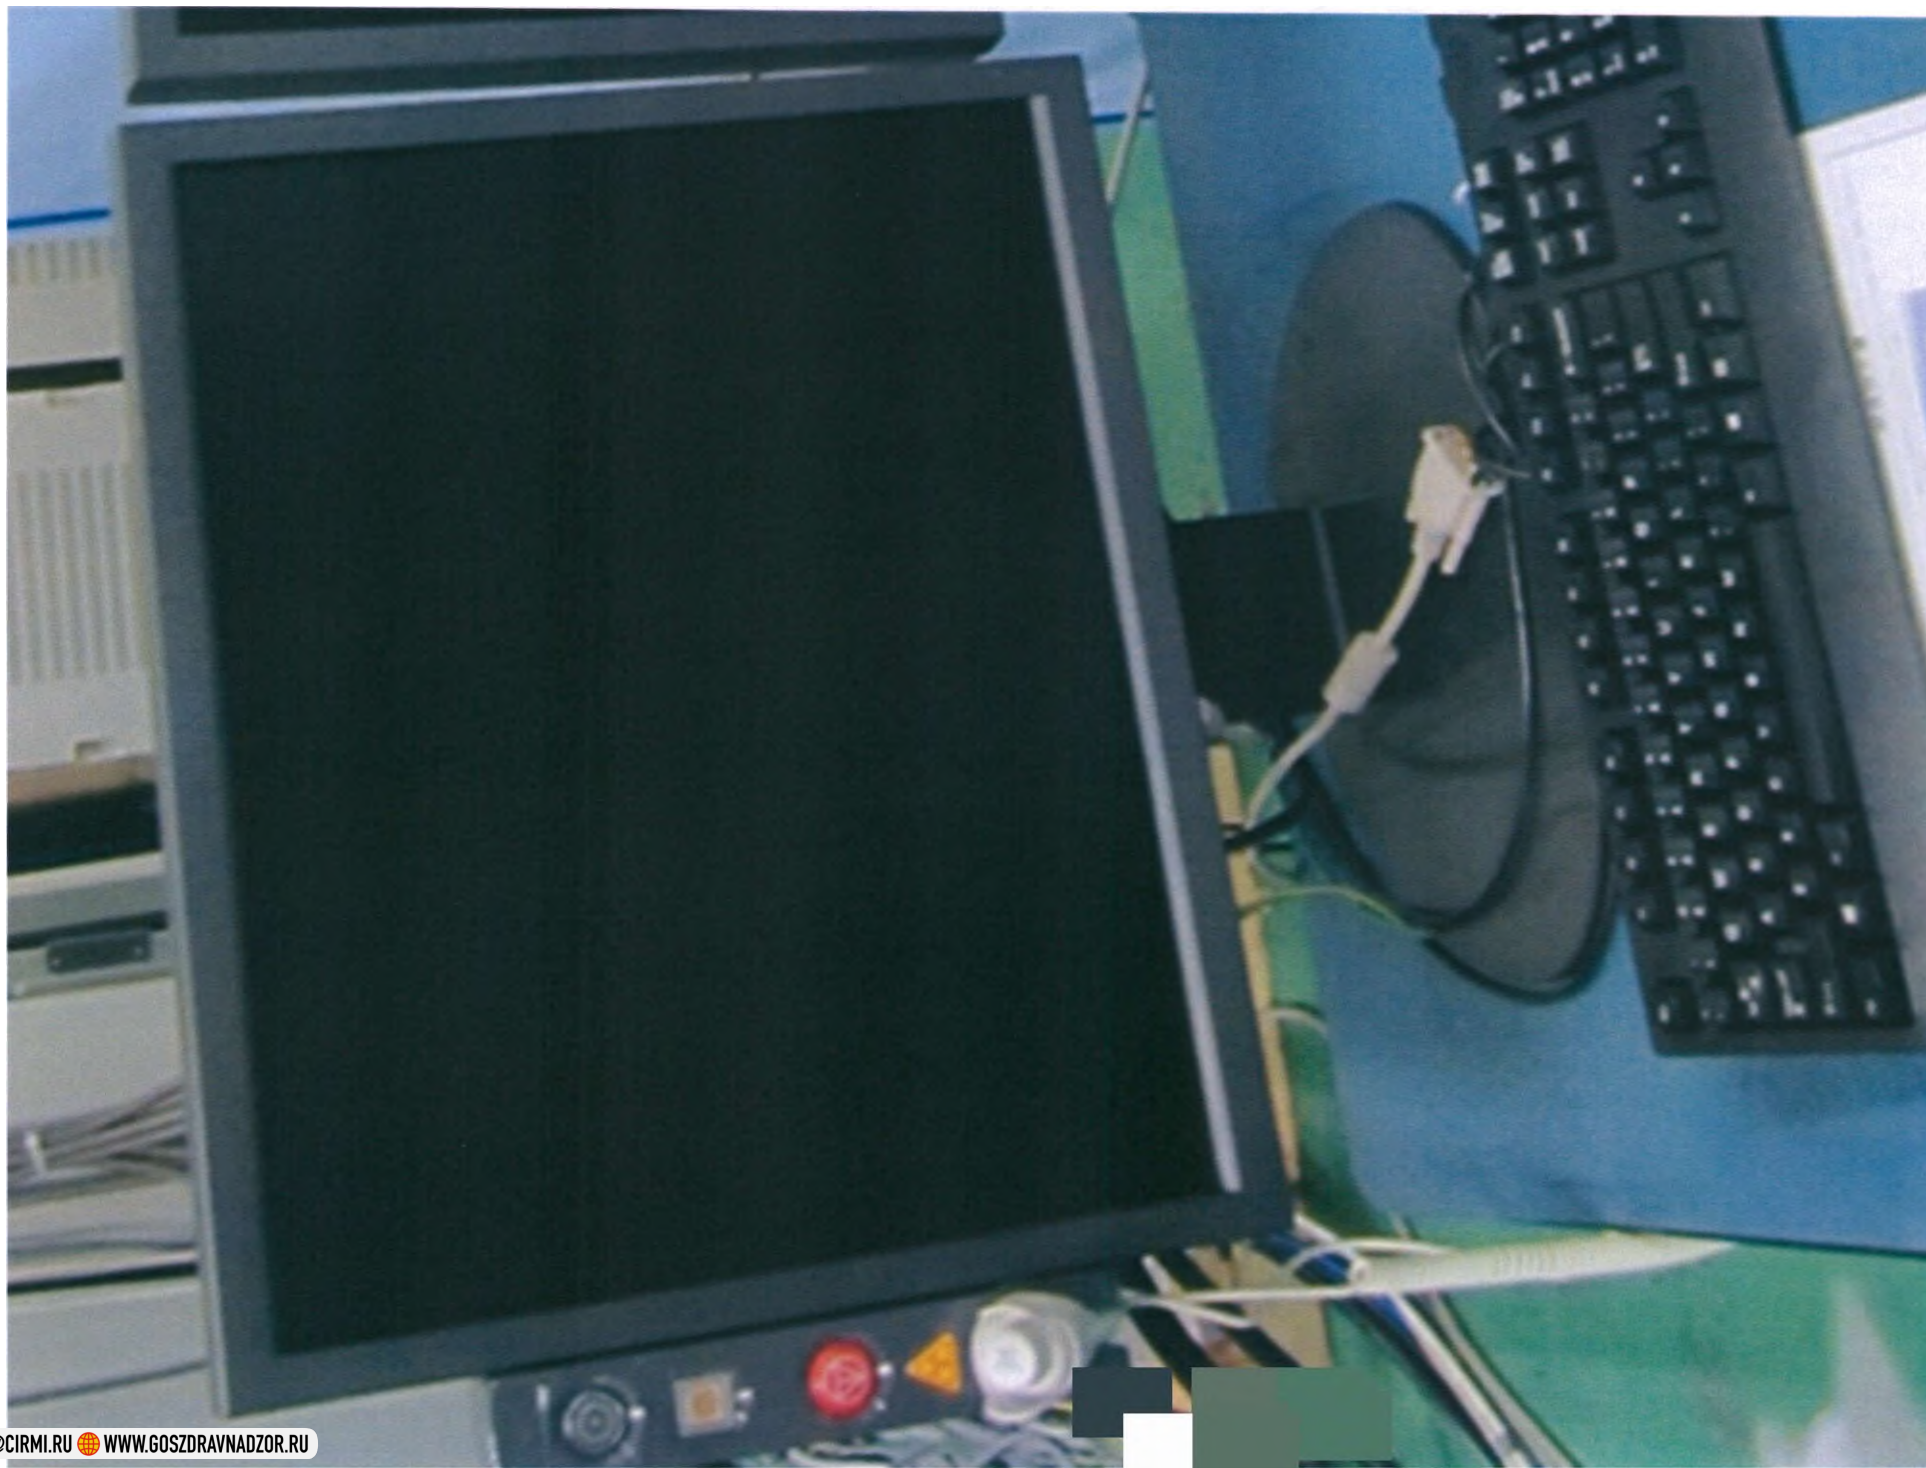



37. Модуль точечной рентгеноскопии.

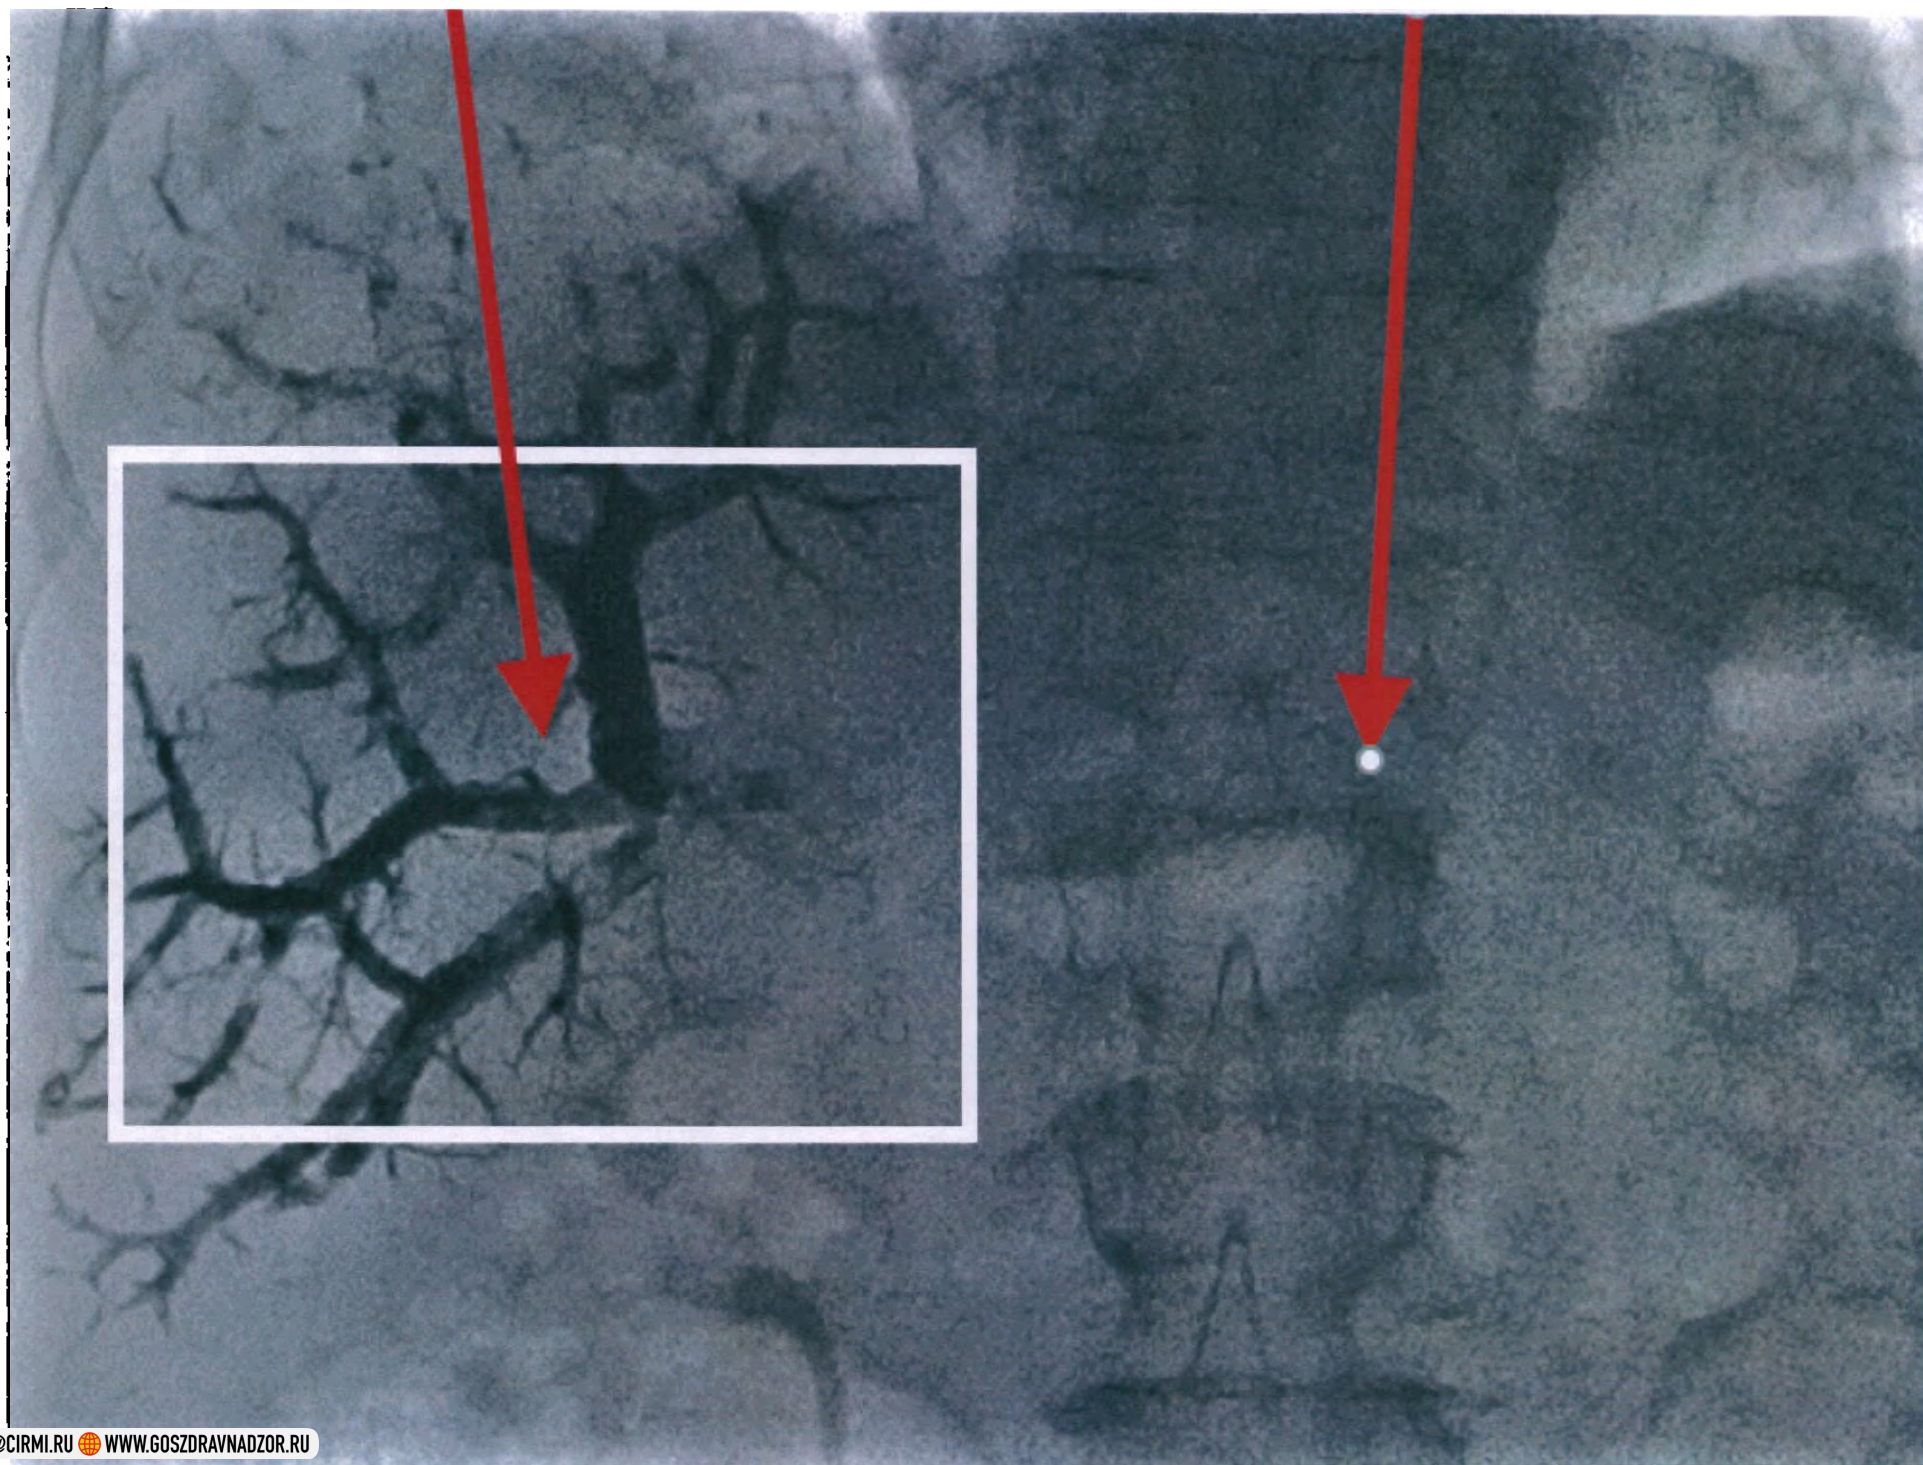

38. Монитор с большим экраном (для цифрового вывода, 48 портов).



Монитор



Многоэкранный сетевой коммутатор



Сенсорный интерфейс пользователя



Коммутатор Summit x670-48x



Кодировщик MNA-120ENC-DVI

39. Цифровое кодирующее устройство для добавления двух входных каналов DVI.




40. Комплект для добавления контрольного монитора.





Панель -
заглушка

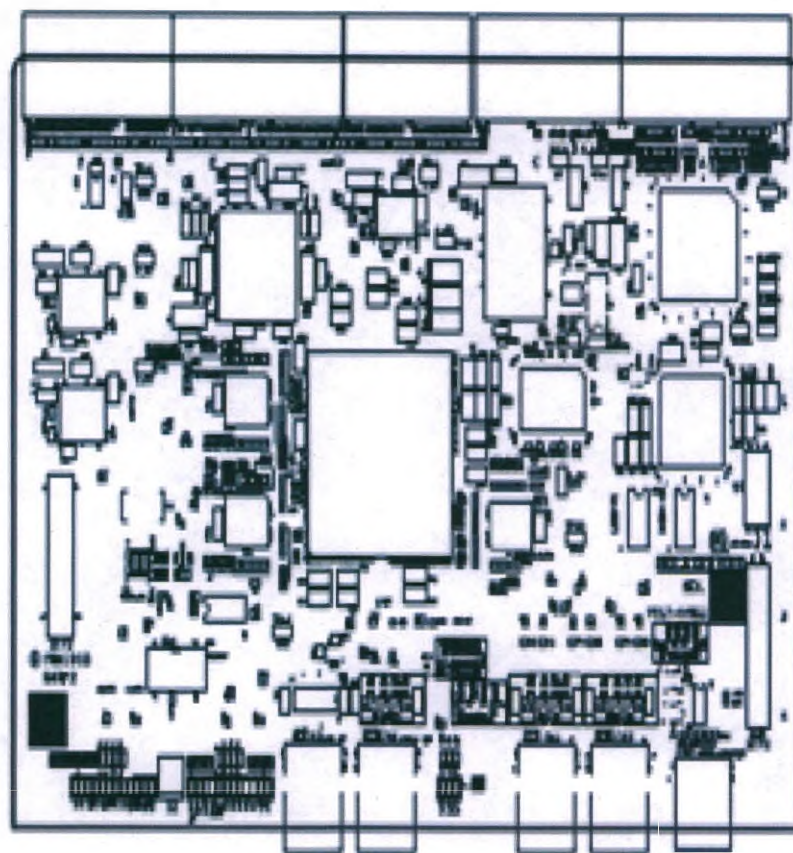

эл.плата
SNRF2 pwb

комплект встроен
внутри системного
шкафа



CAAS SETTINGS

CAL

LVA

RVA

QCA

QVA

About

Local Reference Method

☒ Mean local 1
 ☐ Mean local 2
 ☐ Interpolated

Default Analysis Method

Total Analyzed Segment

Local Diam Average Width

3

mm

Local Ref Average Width

3

mm

Maximum Diameter

50

☒ Snap Lesion At Local Minimum


Default



OK

Cancel







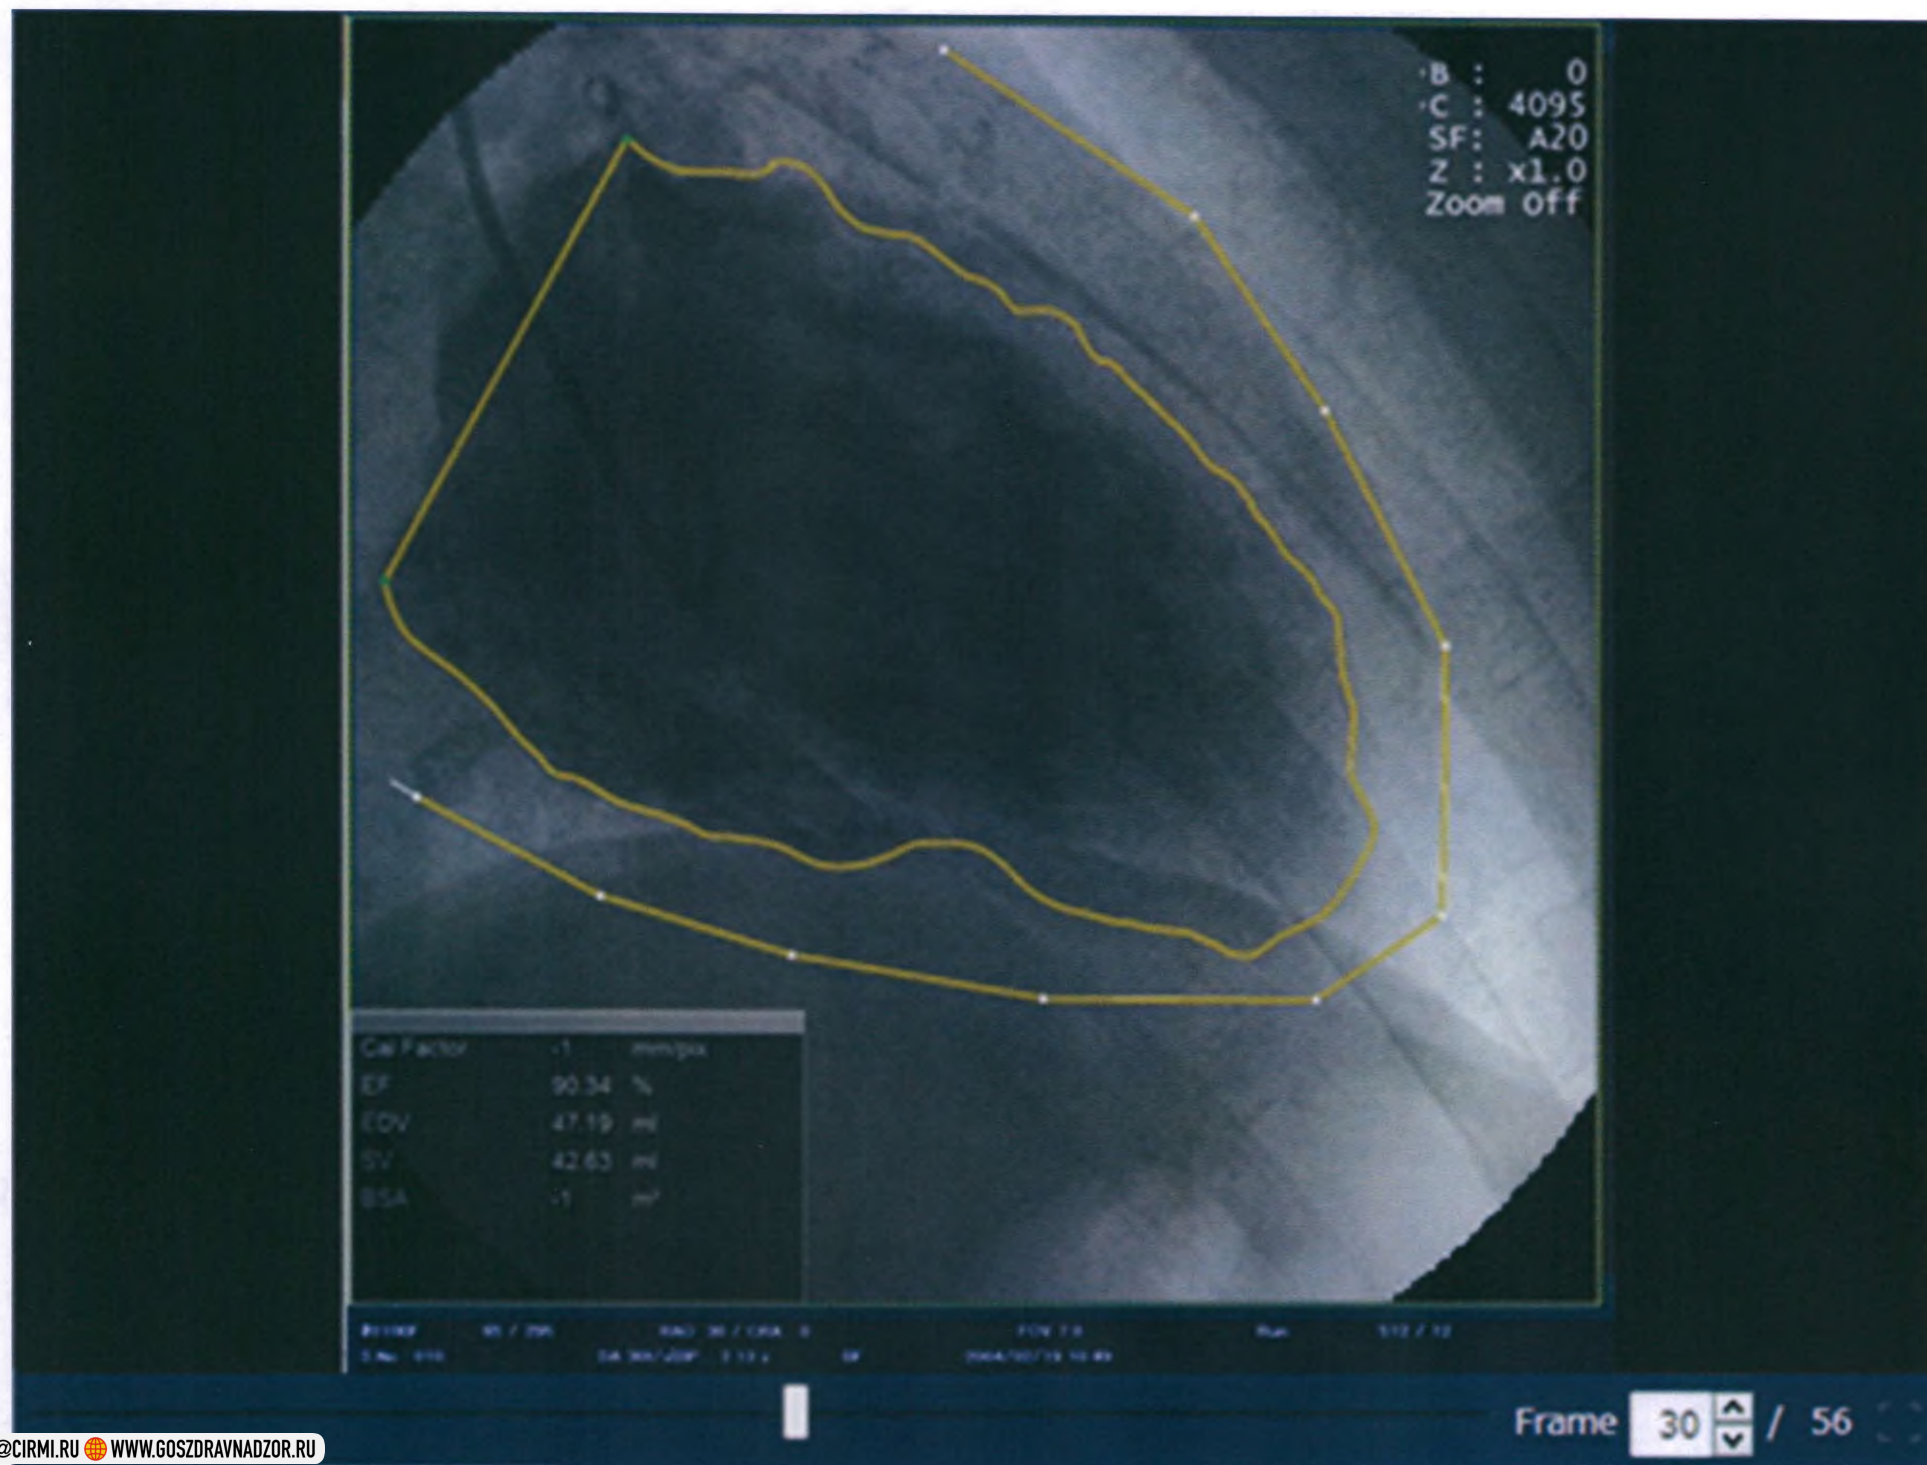


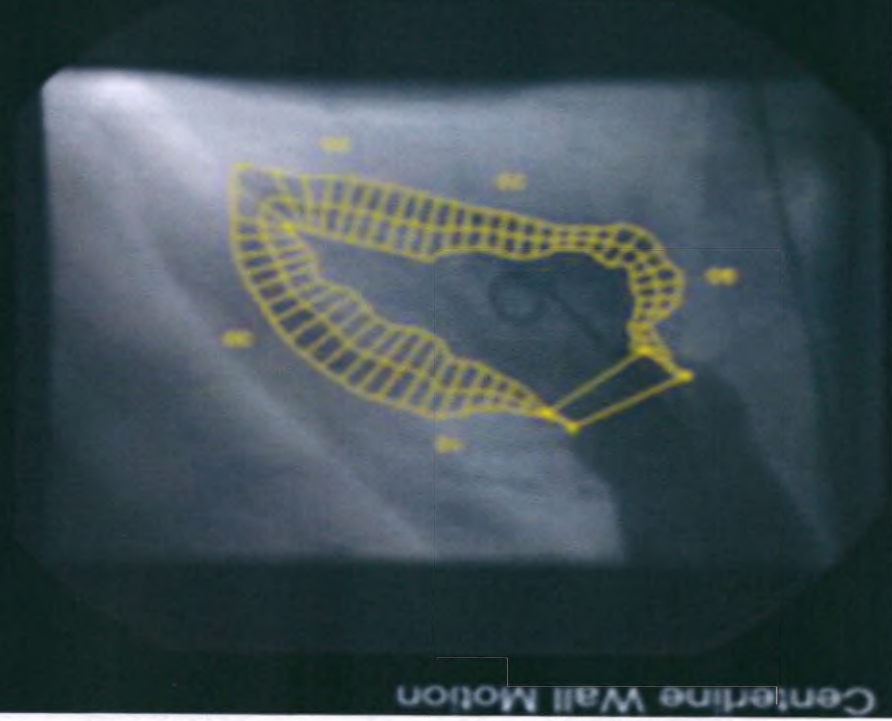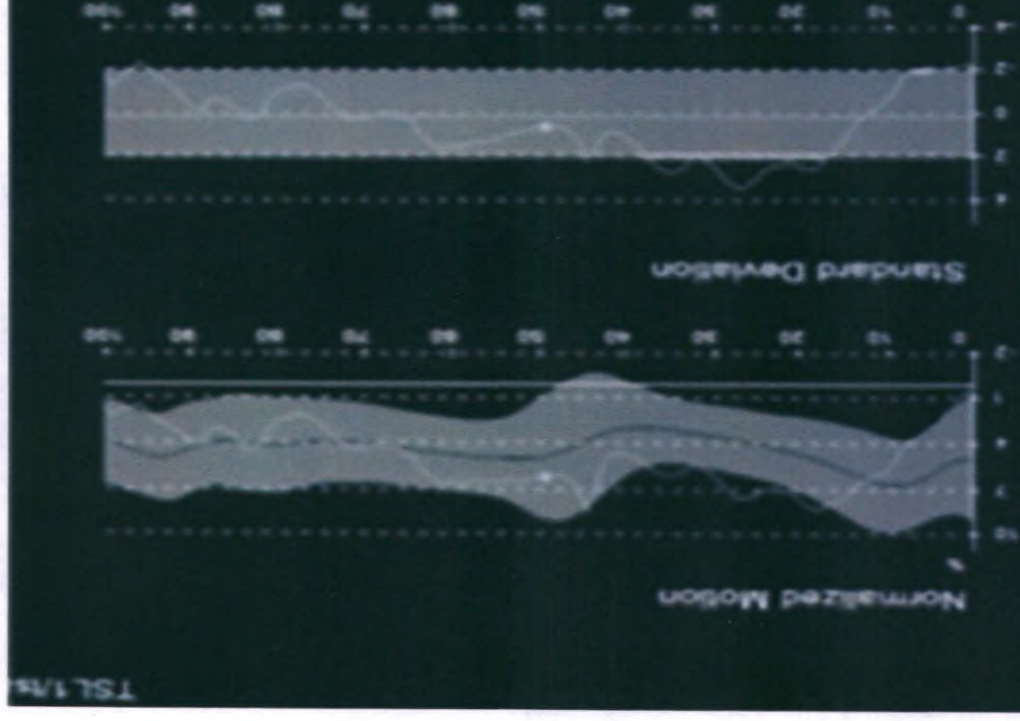


Extent				Territorial			
(+/- 2 Sdev)							
Hypokinetic	3	Start	End	LAD	Hyper	2.3	0.8
Hyperkinetic	21	5	7	Mult LAD <td>Hyper</td> <td>2.4</td> <td>0.8</td>	Hyper	2.4	0.8
Akinetic	-	18	38	Mult RCA <td>Hyper</td> <td>2.4</td> <td>0.8</td>	Hyper	2.4	0.8
LAD				RCA			
Length				Length			
Start				Start			
End				End			
Type				Opp. Type			
Severity (Sdev)				Opp. Severity (Sdev)			
Hyper				Hyper			
Hyper				Hyper			
Hyper				Hyper			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			
Hyper				Hypo			

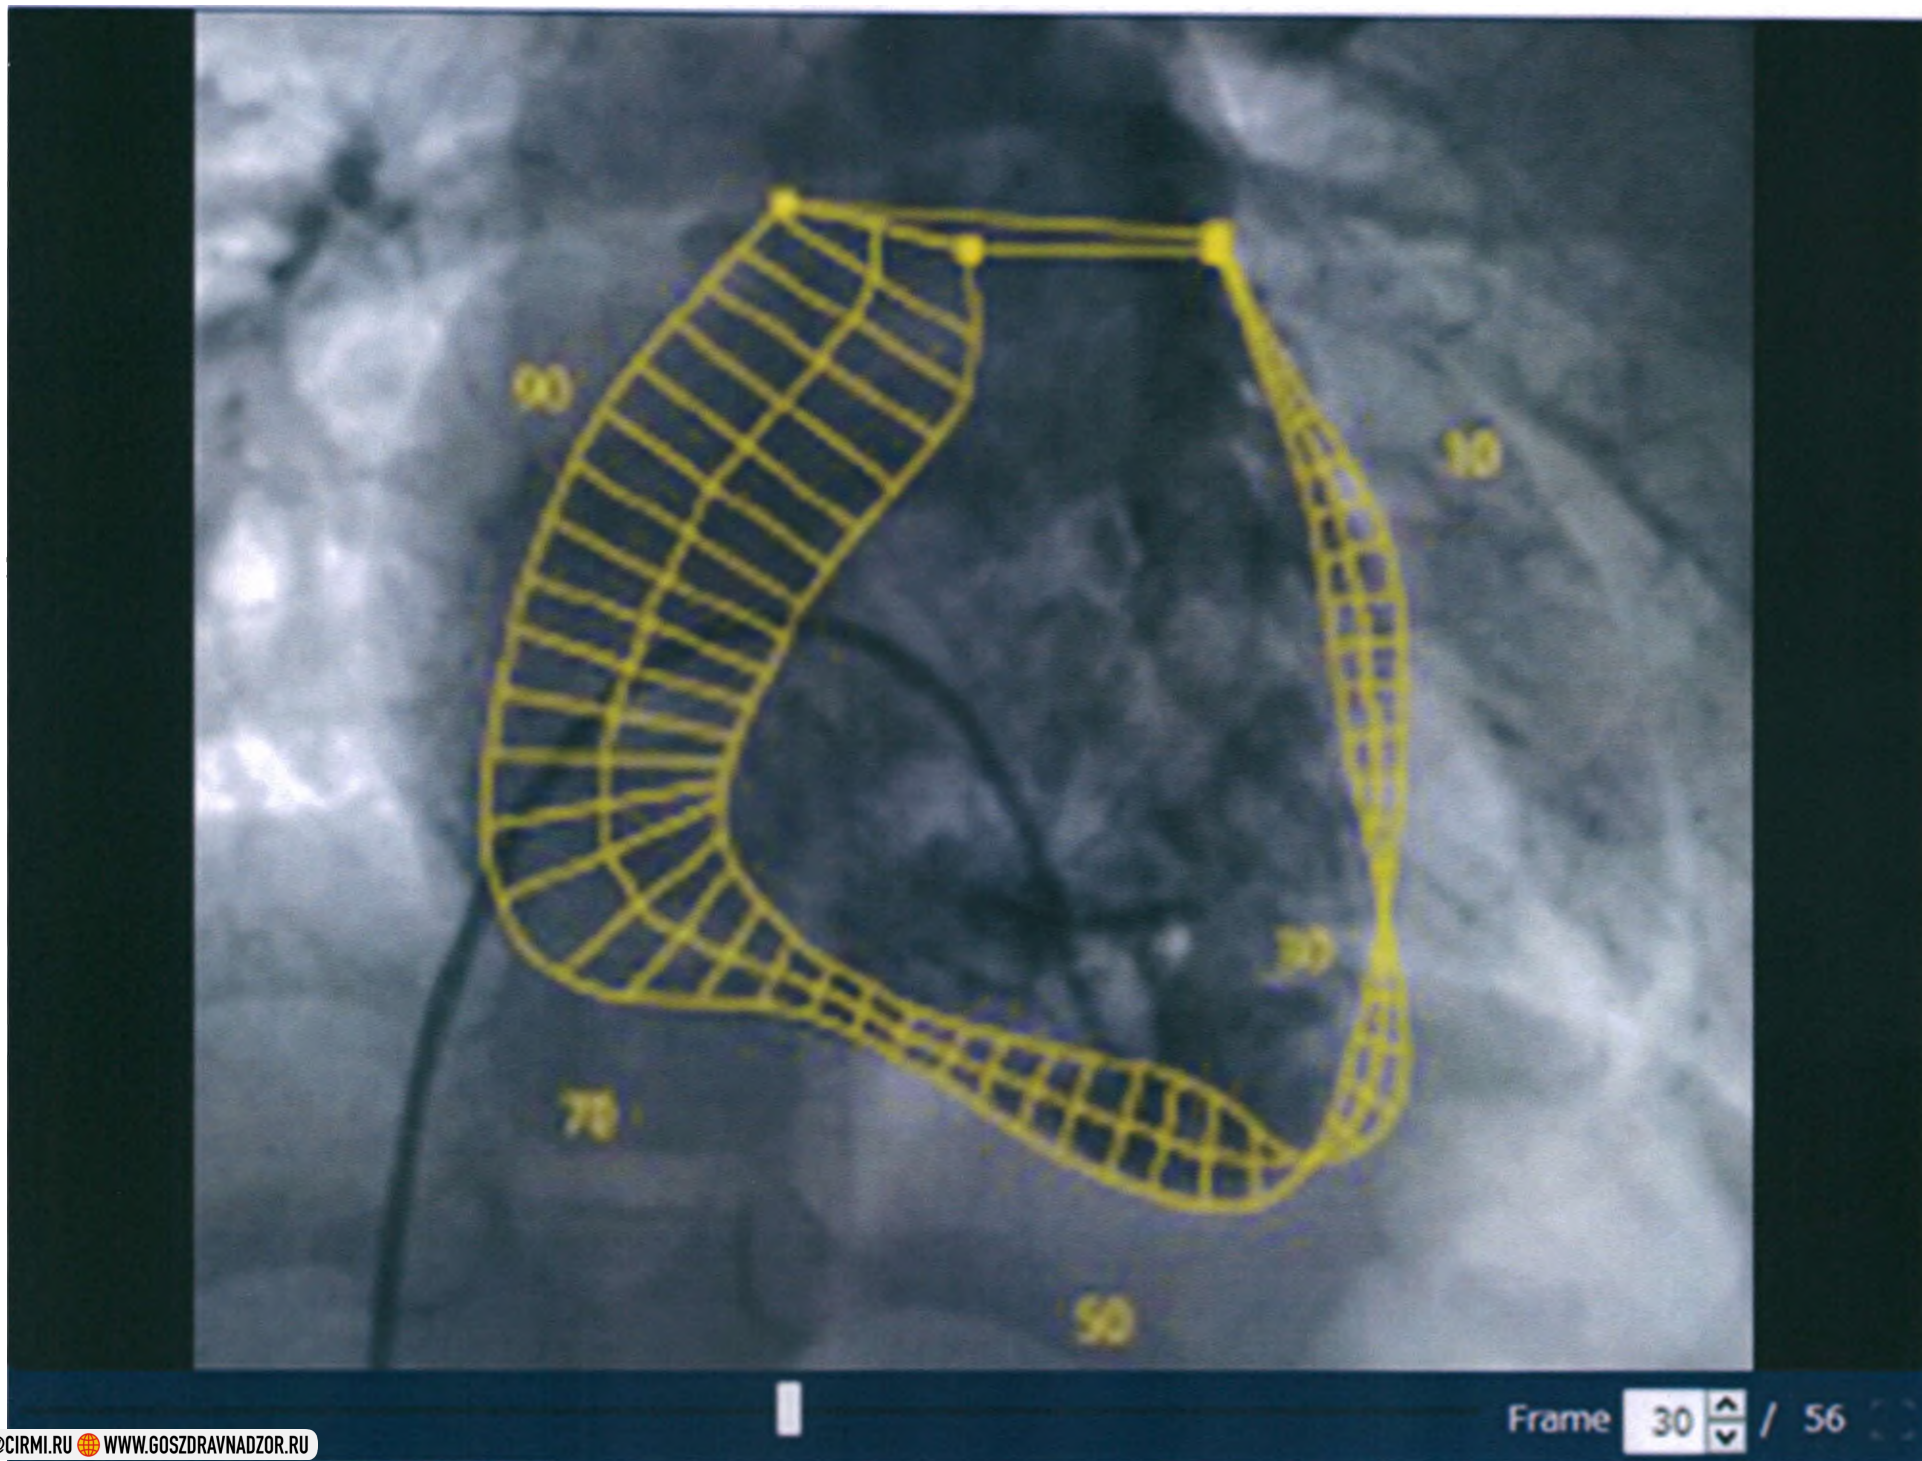

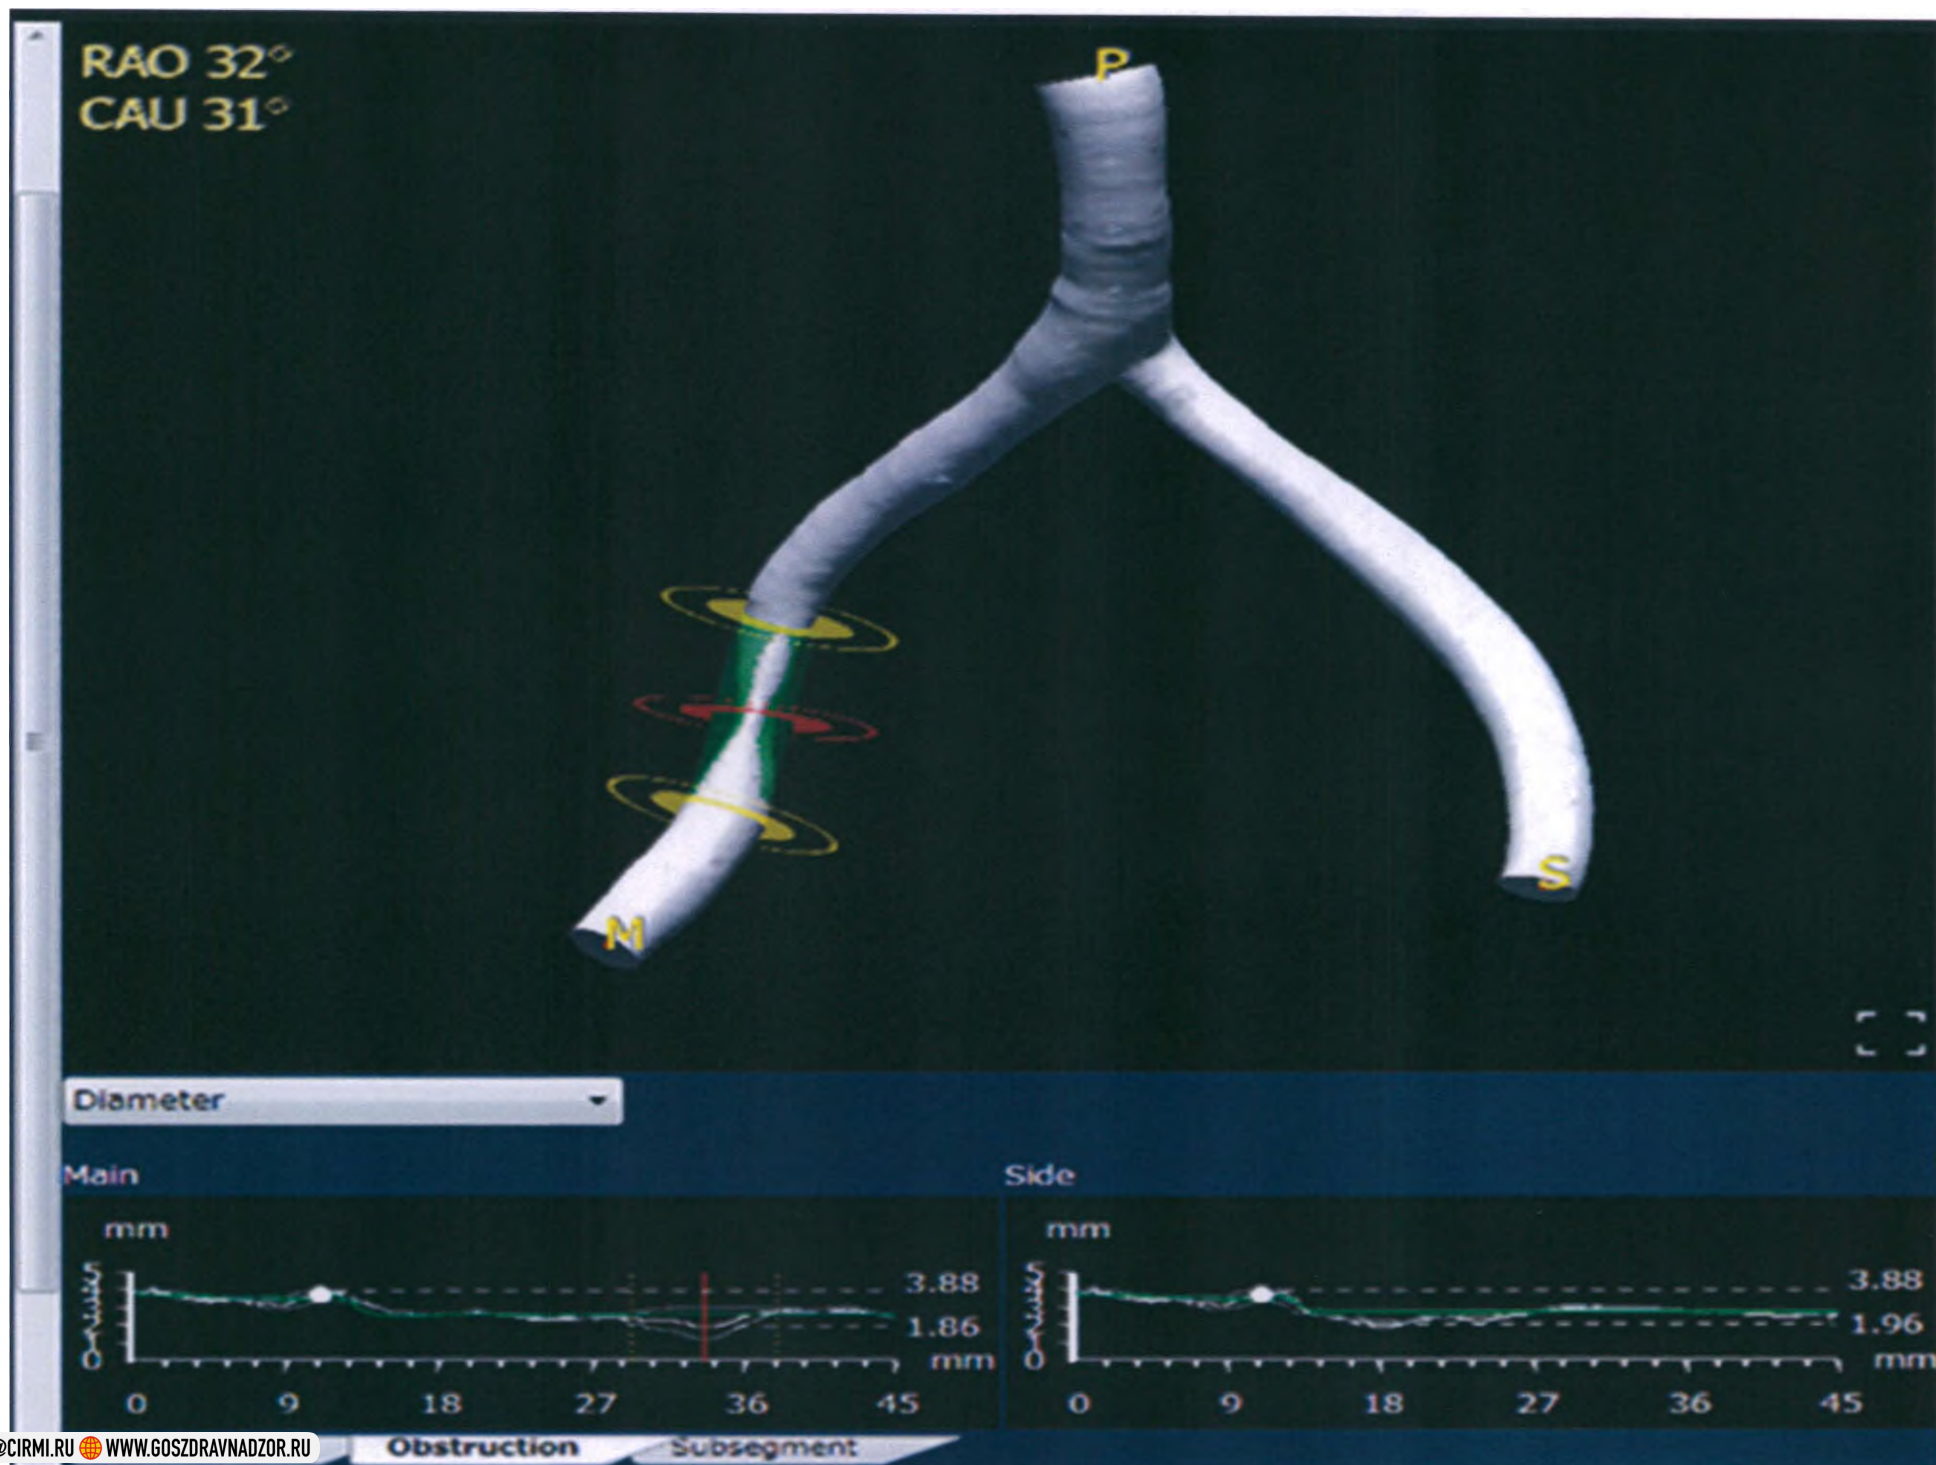


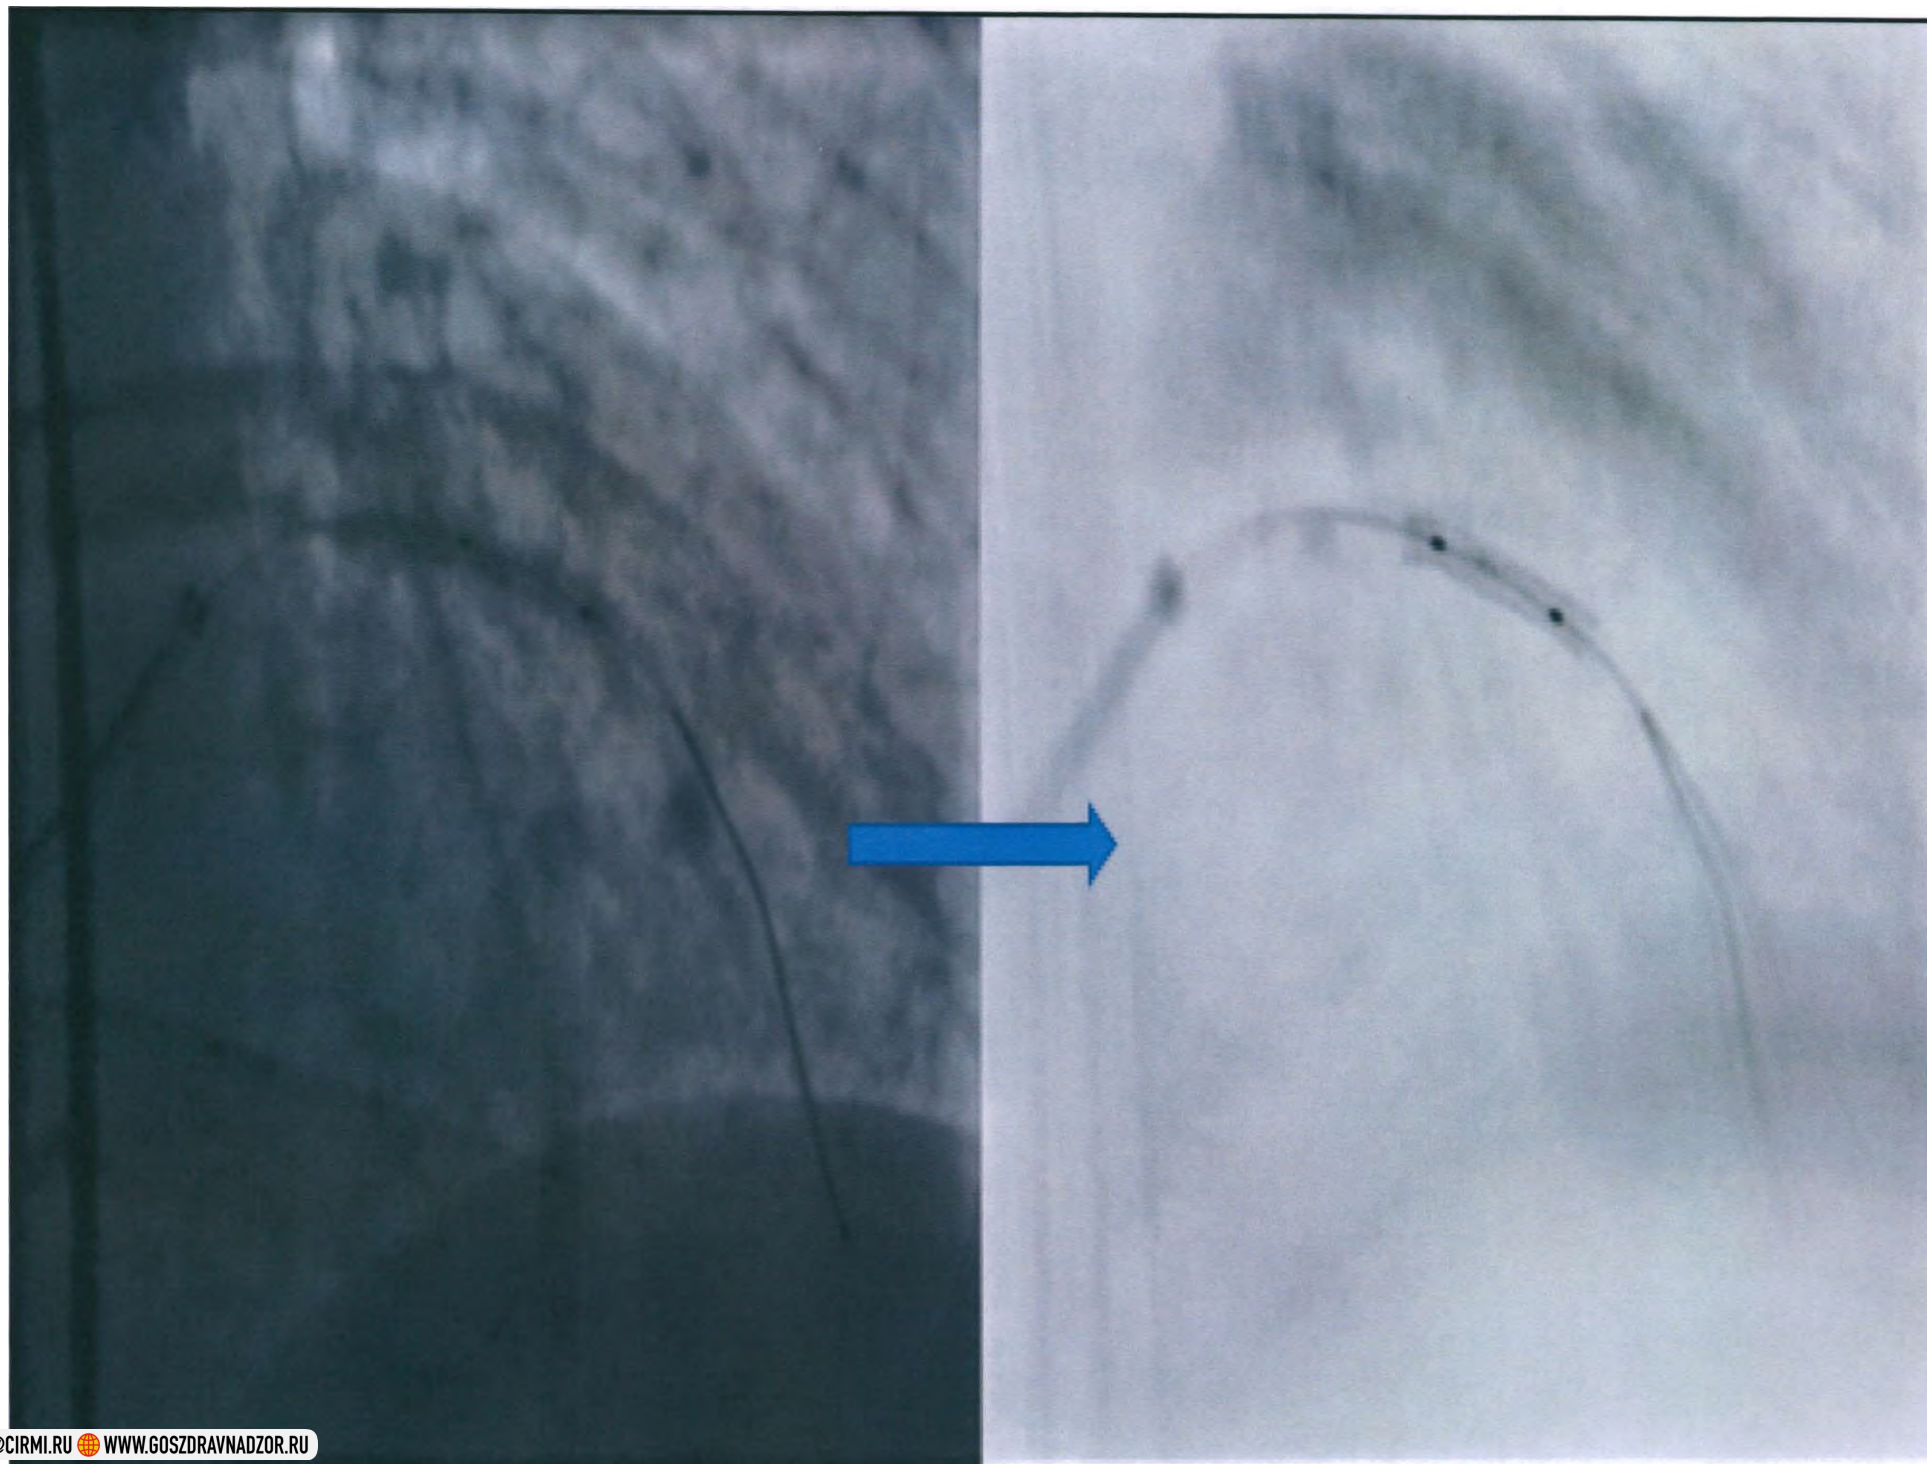


50. Монитор 19-дюймовый или монитор 34-дюймовый, не более 5 шт.

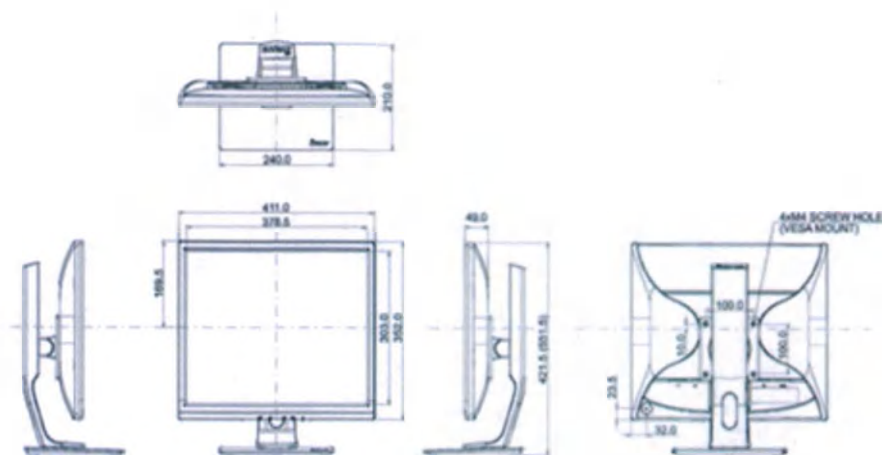


Модель монитора «IIYAMA Prolite», размер диагонали 19 дюймов

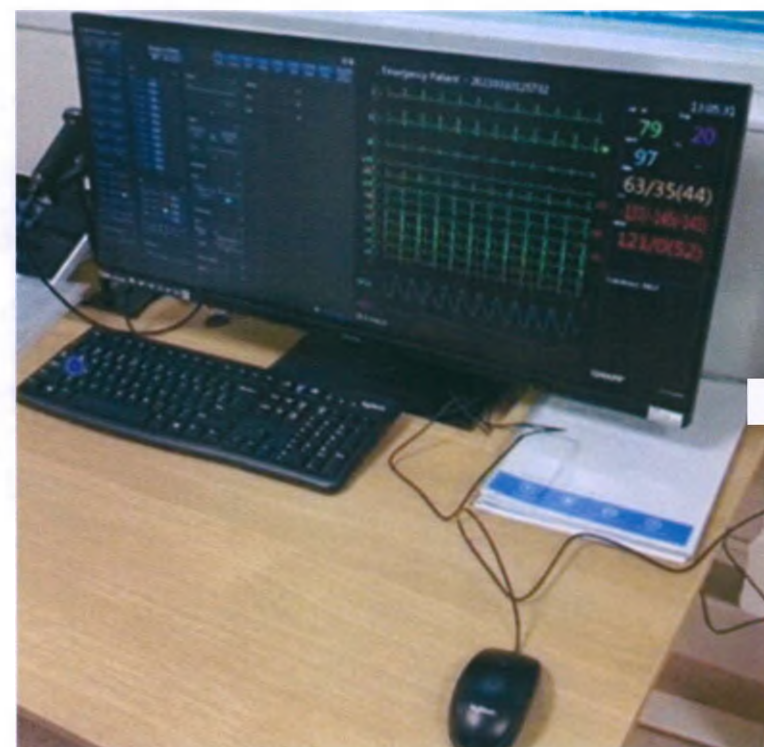



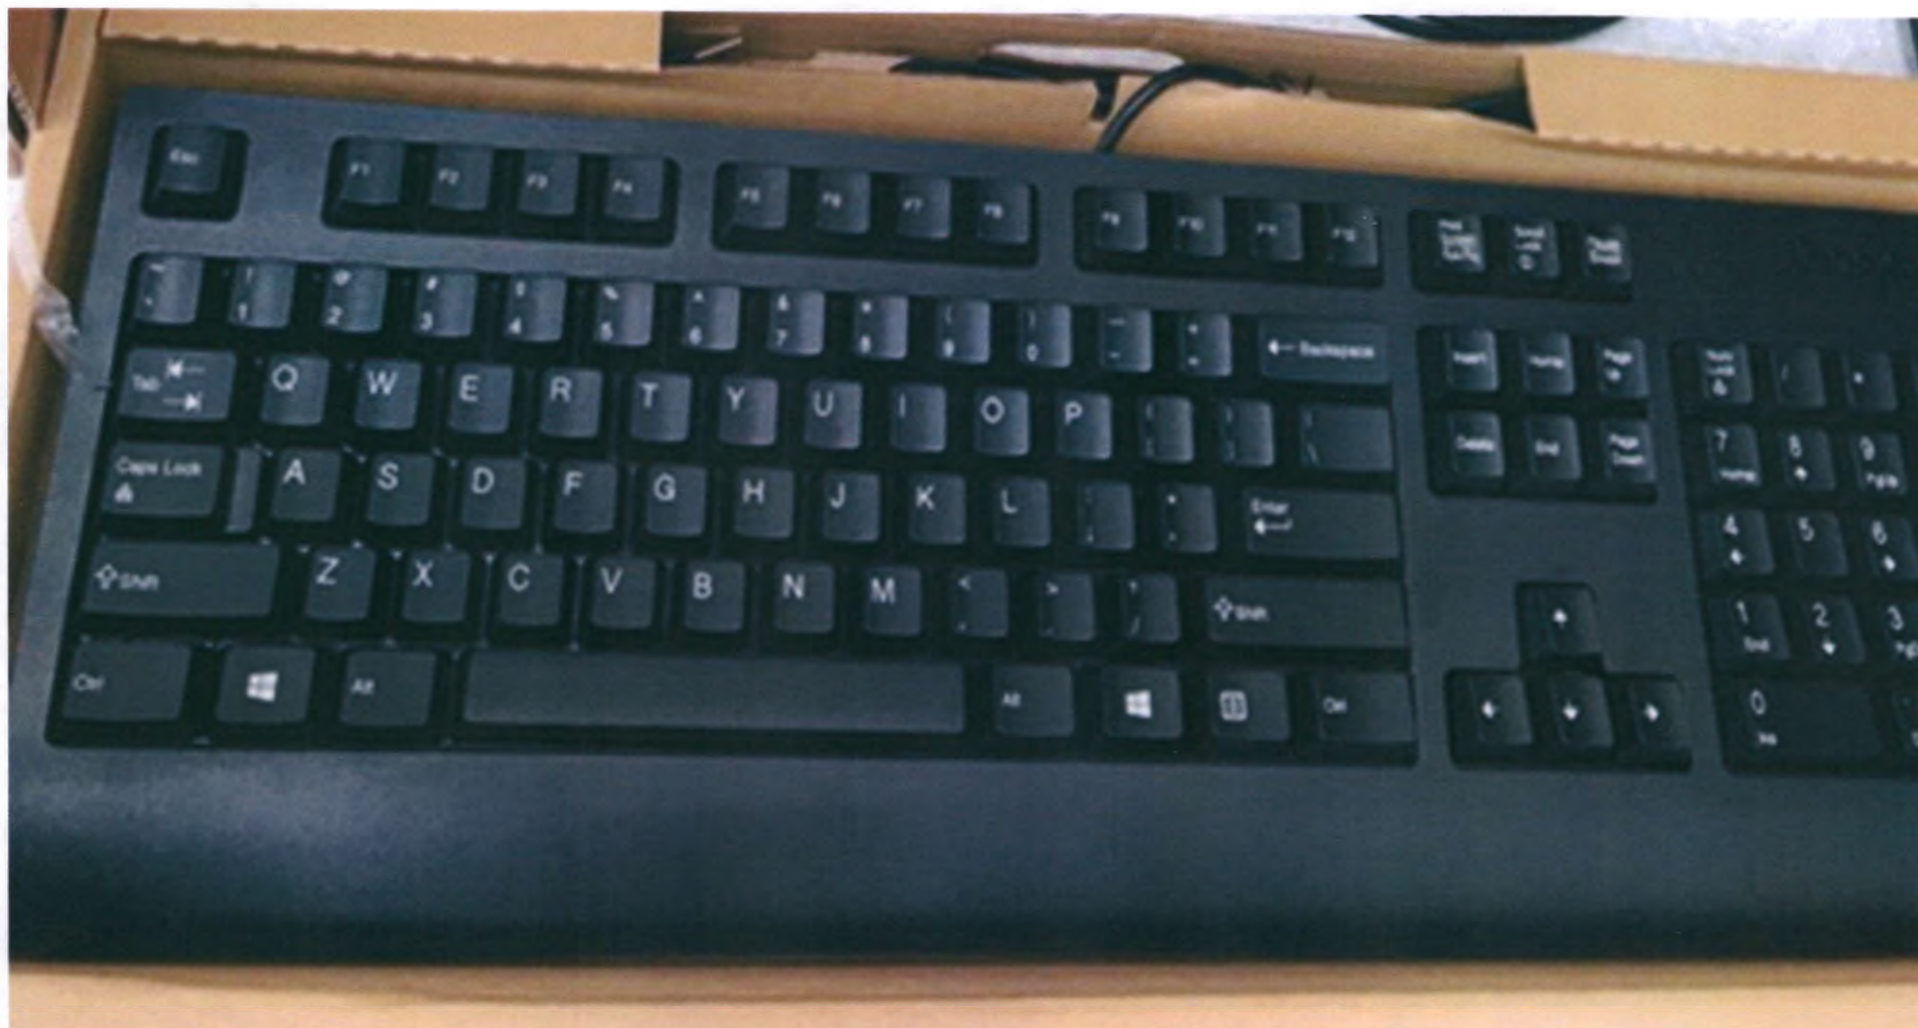

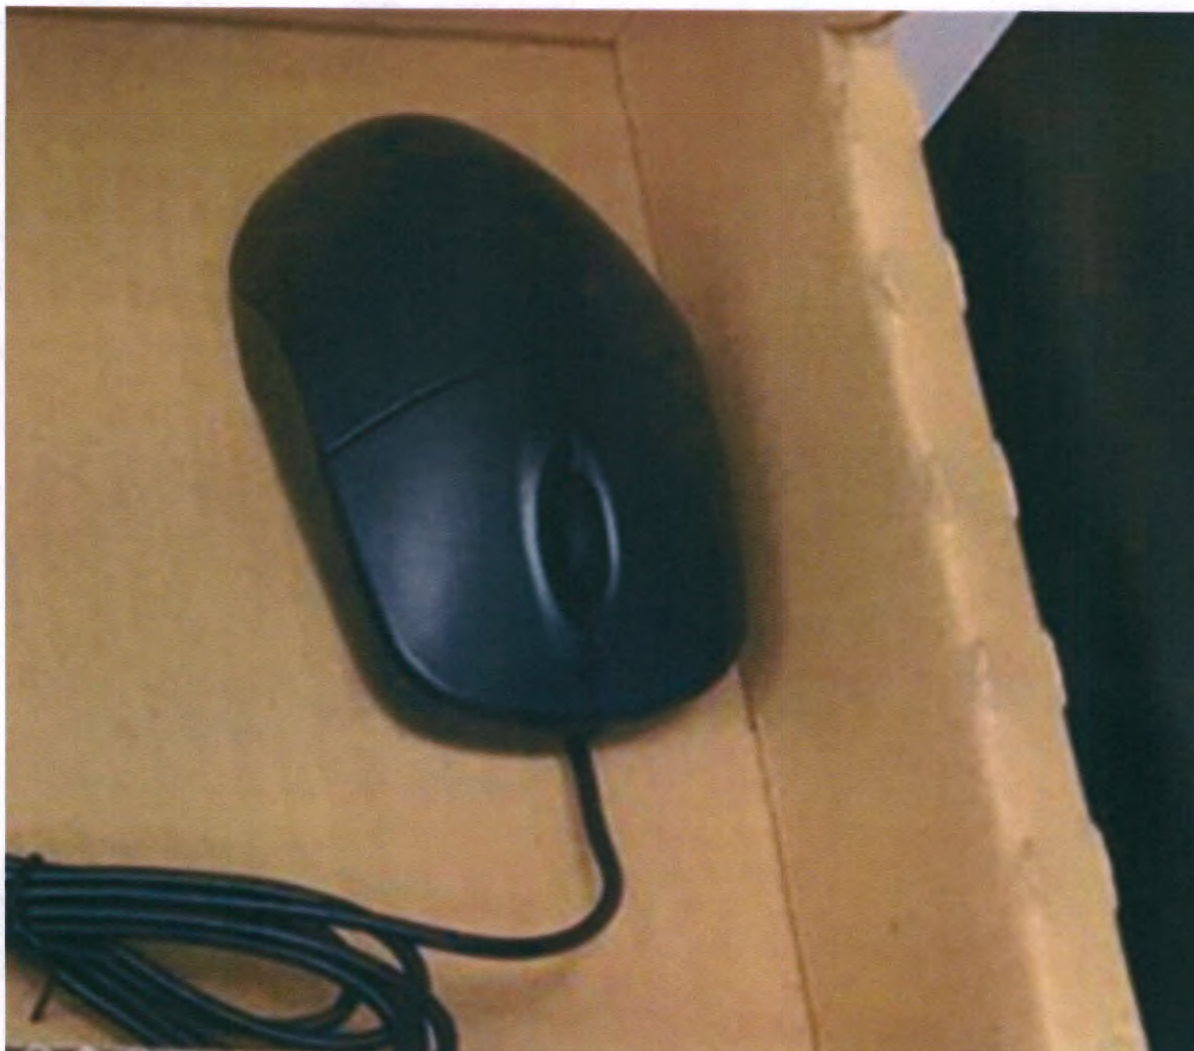



55. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоразовая NIBP, детская (оранжевая), 8-13 см



Манжета многоразовая NIBP, детская (зеленая), 12-19 см



Манжета многоразовая NIBP, маленькая, для взрослых (ярко-синяя), 17-25 см



Манжета многоразовая NIBP, для взрослых (серая), 23-33 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (серая), 28-40 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (бордовая), 40-55 см

55. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.

40/



Манжета многоразовая NIBP, набедренная (коричневая), 38-50 см

56. Кабель соединительный магистральный для ЭКГ, не более 6 шт.






58. Модуль двухканальный для IBP



Кабель для датчика инвазивного измерения давления, длина 320 см



Красный коннектор кабеля-удлинителя IBP к разъему с надписью IBP на усилителе QMAPP.

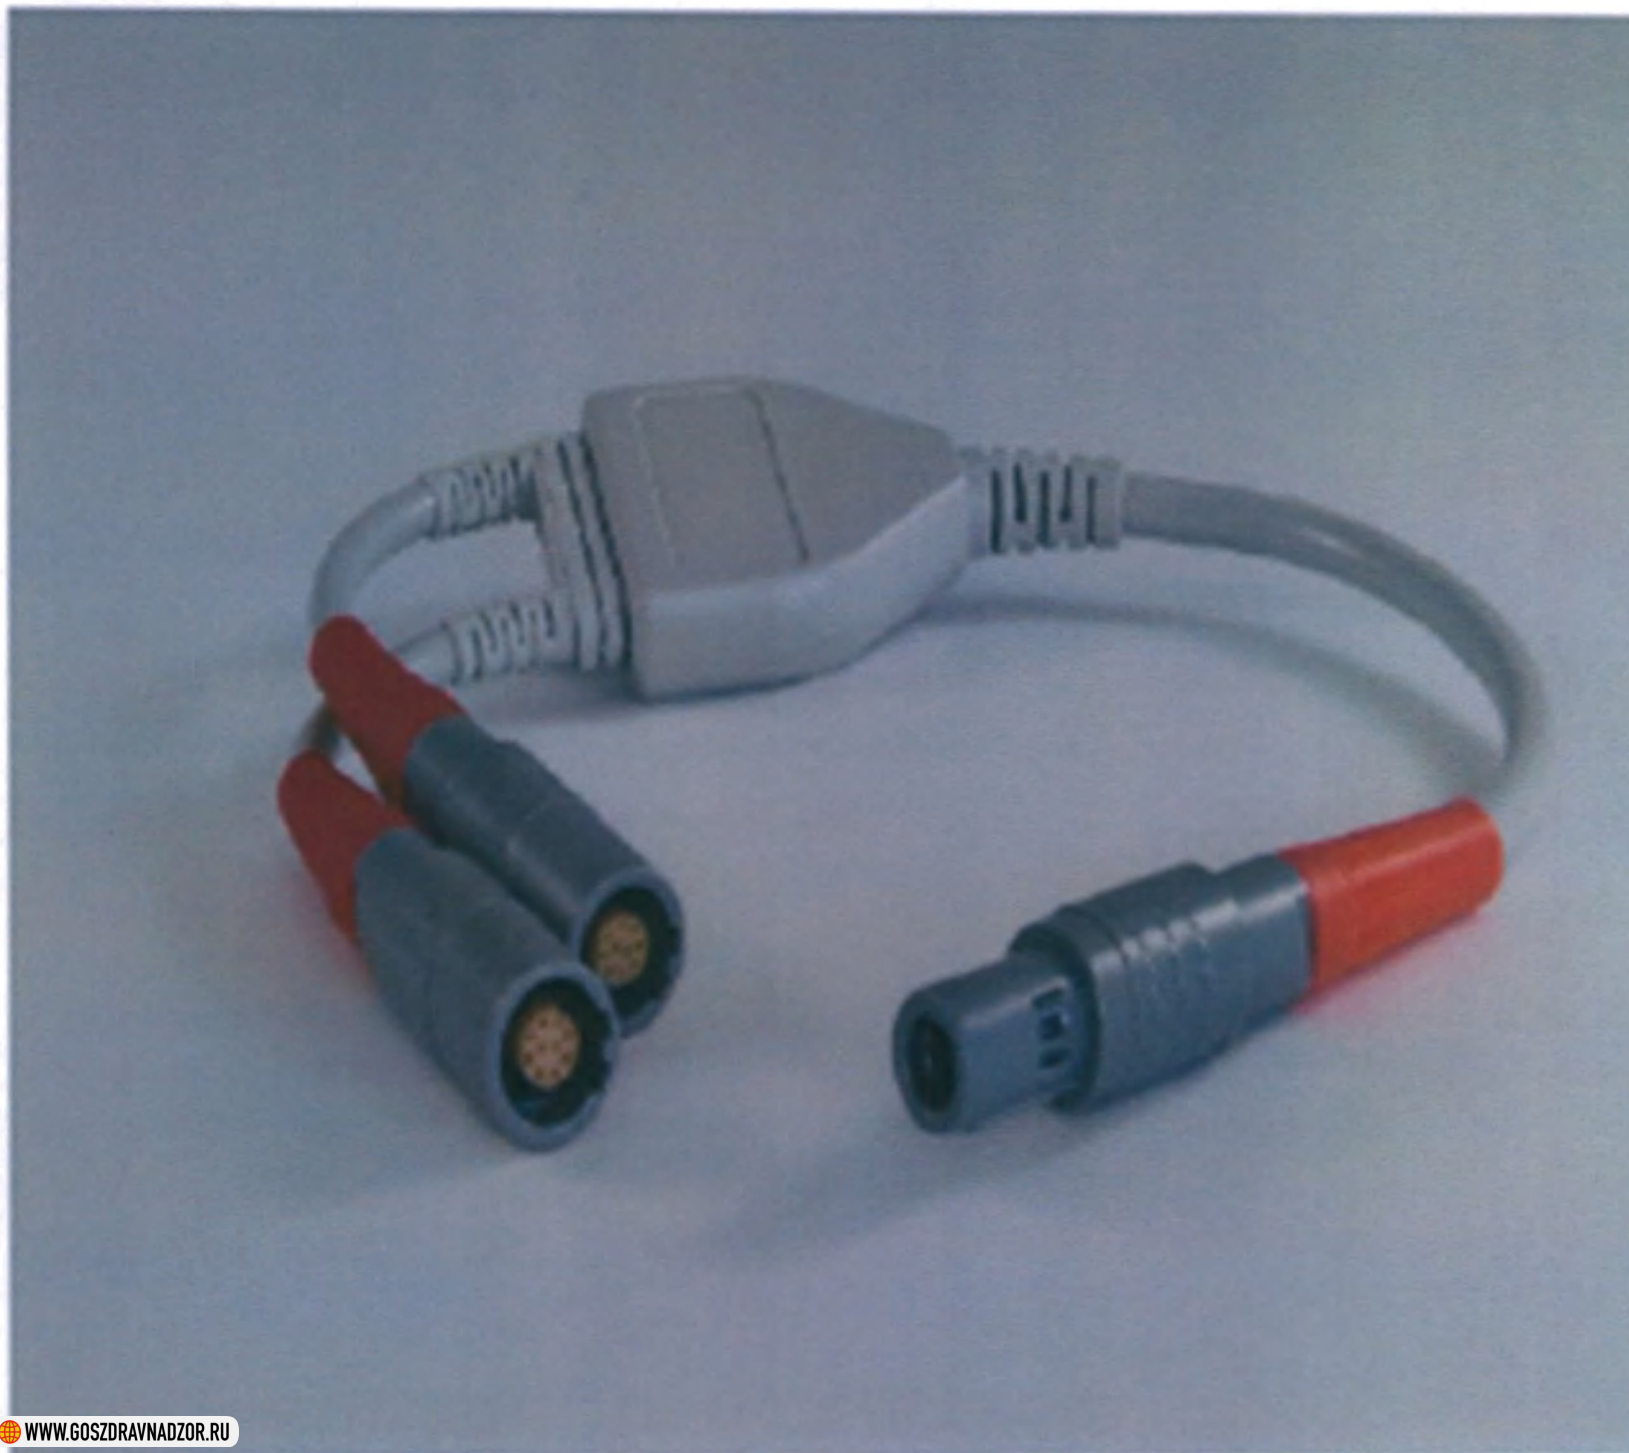





61. Кабель соединительный для модуля IBP, не более 6 шт.





63. Модуль измерения сердечного выброса методом термодилуции

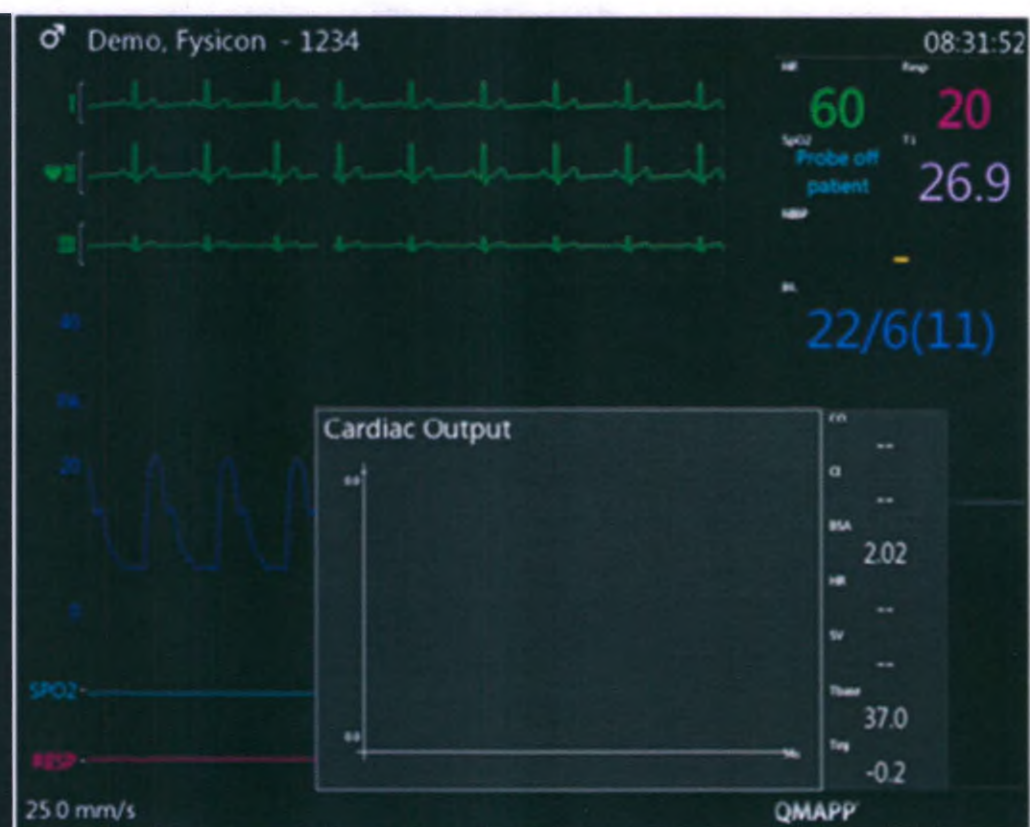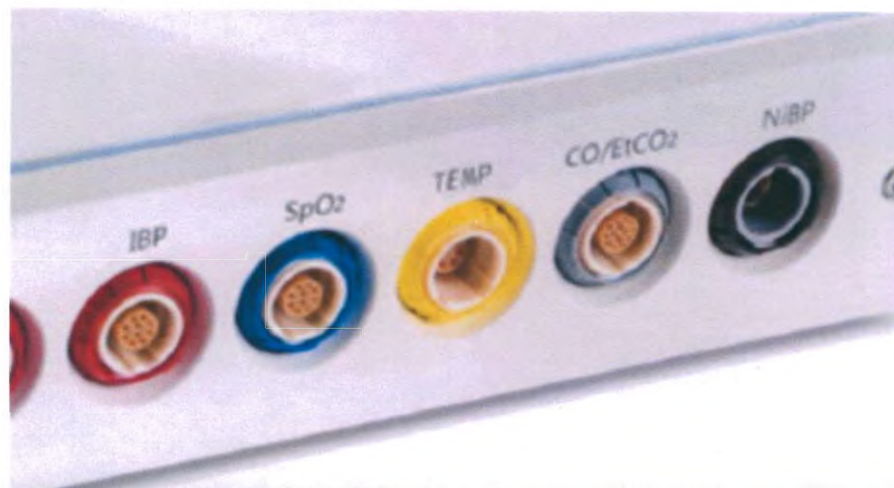

64. Комплект для измерения сердечного выброса методом термодилуции, в составе:- кабель для измерения сердечного выброса методом термодилуции, не более 2 шт.;



64. Комплект для измерения сердечного выброса методом термодилуции, в составе:

- датчик для измерения сердечного выброса методом термодилуции, не более 2 шт.



65. Модуль для регистрации фракционного резерва кровотока.

FFR 

Mode:
Monitoring ▼

Channel:
Pa (AO pressure) ▼
Pd (AOPd pressure wire) ▼

Averaging: **Short** ▼

Equalize
Record FFR

FFR 

Mode:
Measurement ▼

Channel:
Pa (AO pressure) ▼
Pd (AOPd pressure wire) ▼

Averaging: **Middle** ▼

Equalize
Record FFR

66. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.



Кабель типа 6.3 мм «Mono Jack» для «Volcano i5», длина 320 см



Кабель для регистрации давления для «Volcano», длина 320 см




Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:



Кабель для регистрации давления Pa Pb для «Boston Scientific», длина 320 см:

66. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.

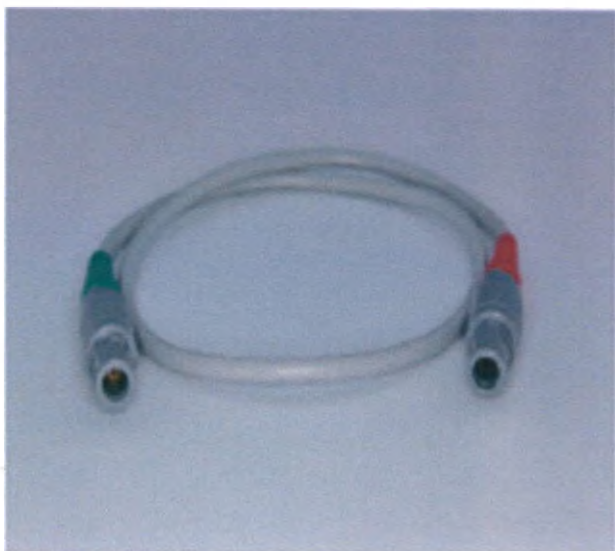

кабель Abbot длиной 65 см




кабель Abbot длиной 320 см





кабель для Abbot Wibox длиной 320 см


Кабели для регистрации давления для «Abbot», Abbott (SJM) Wibox. QMT0-, длина 65 см и 320 см


67. Блок для регистрации фракционного резерва кровотока

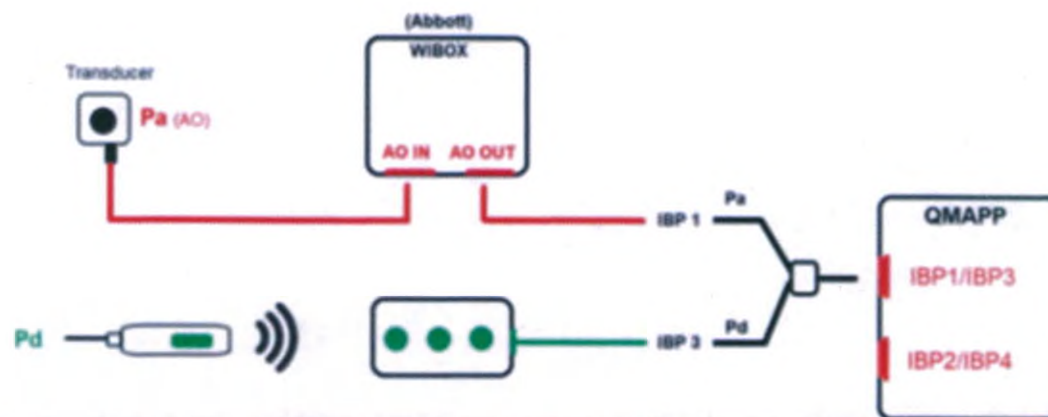

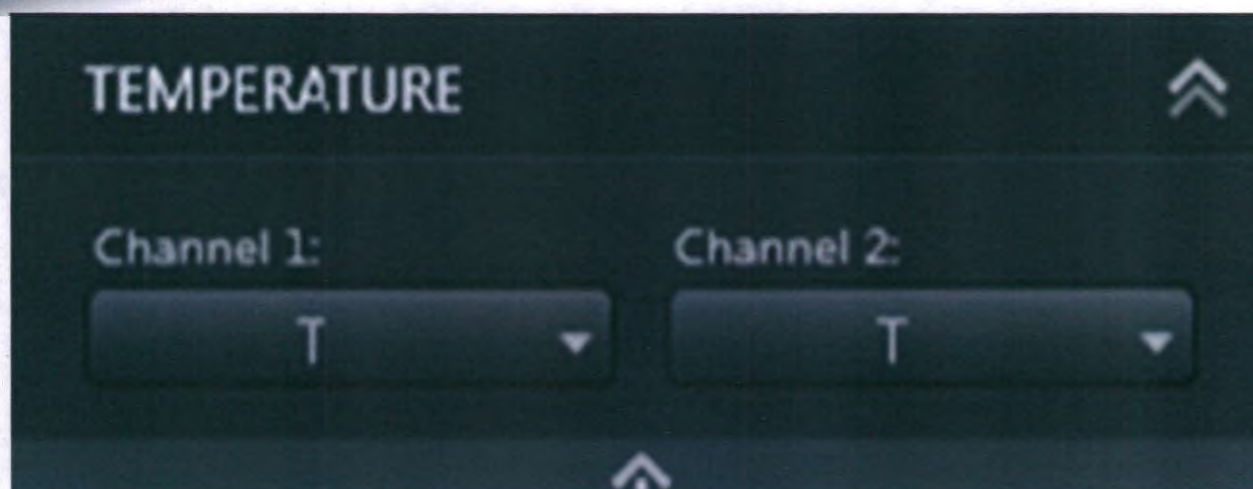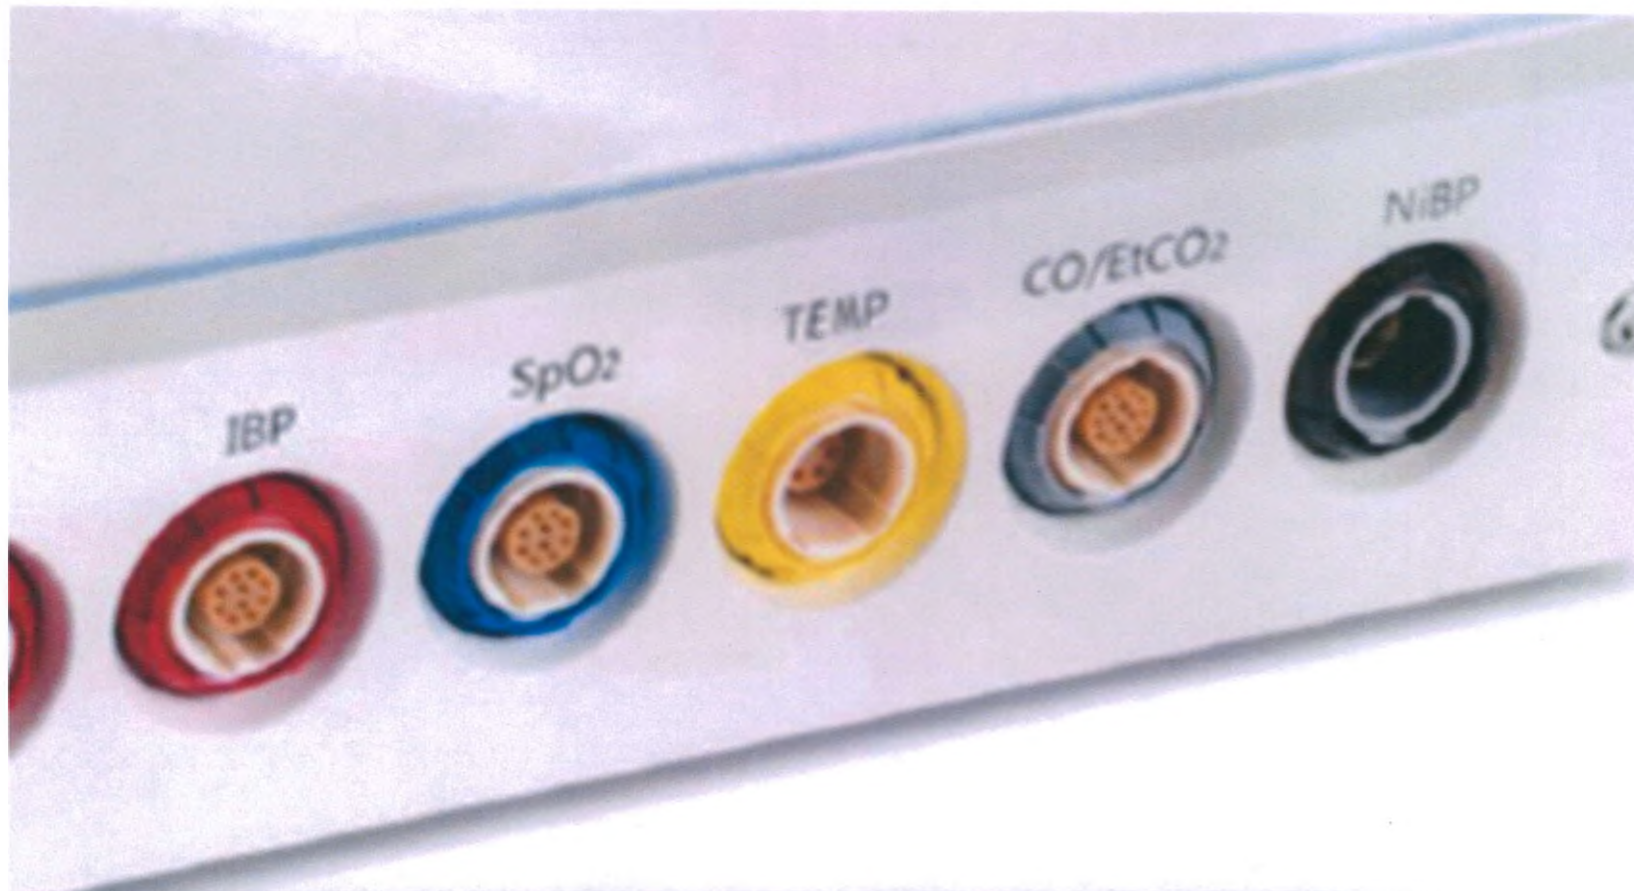



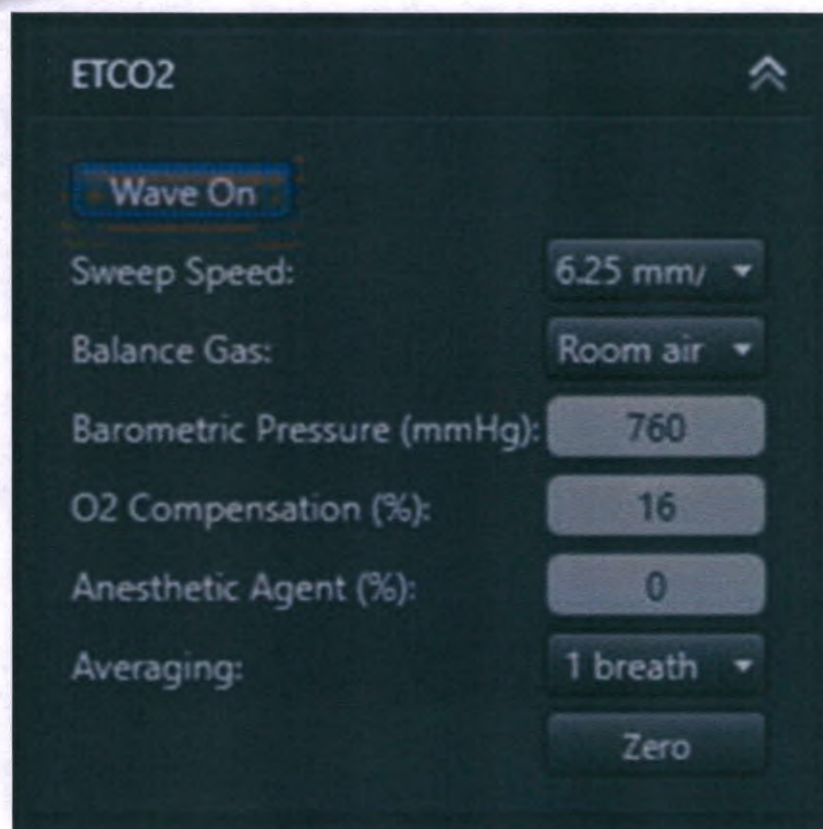

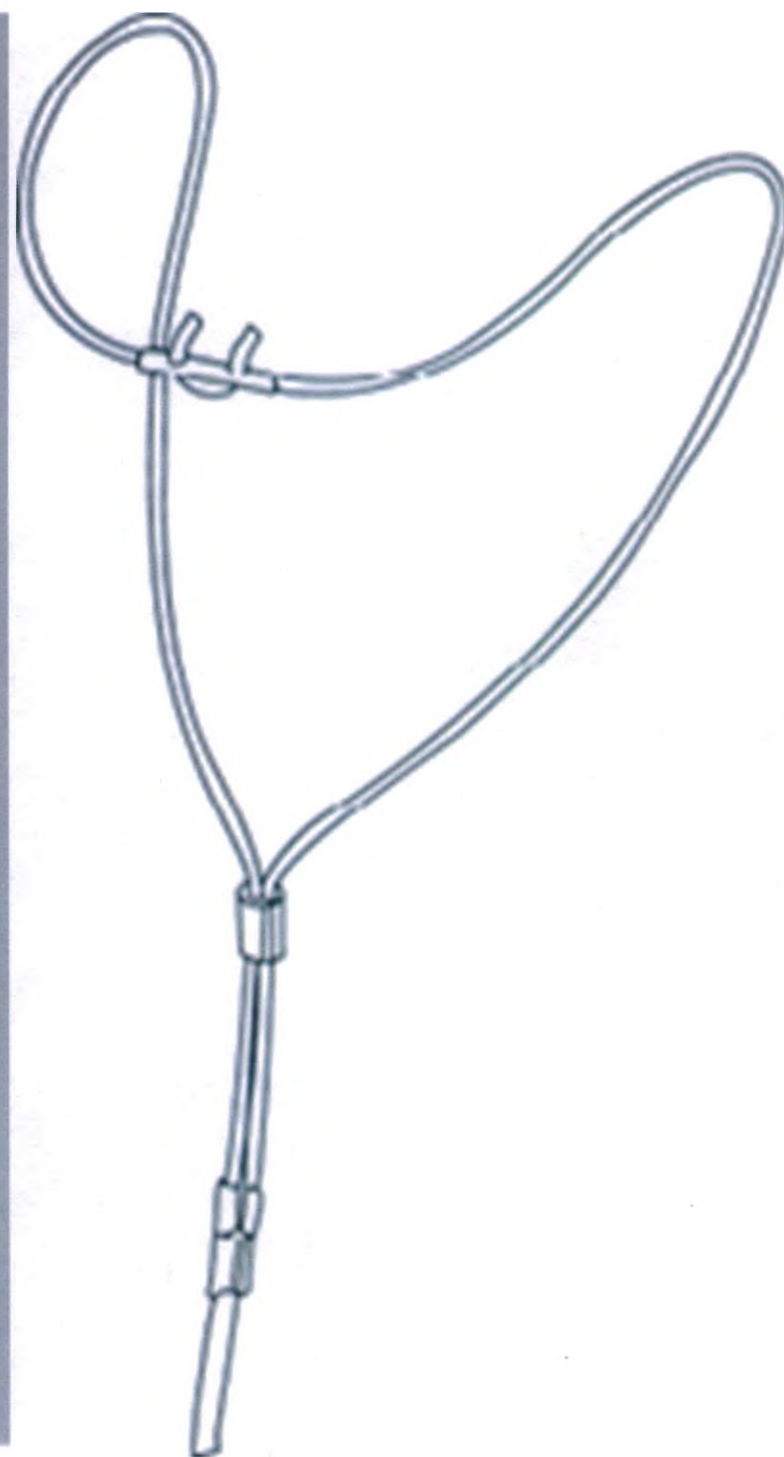



73. Датчик температурный, не более 5 шт.



Датчик кожный, многоразовый для взрослых



Датчик ректальный многоразовый для взрослых.




Датчик центральный многоразовый для взрослых

74. Кабель соединительный для температурных датчиков, не более 3 шт.



75. Кабель для выходного сигнала AUX, не более 3 шт.

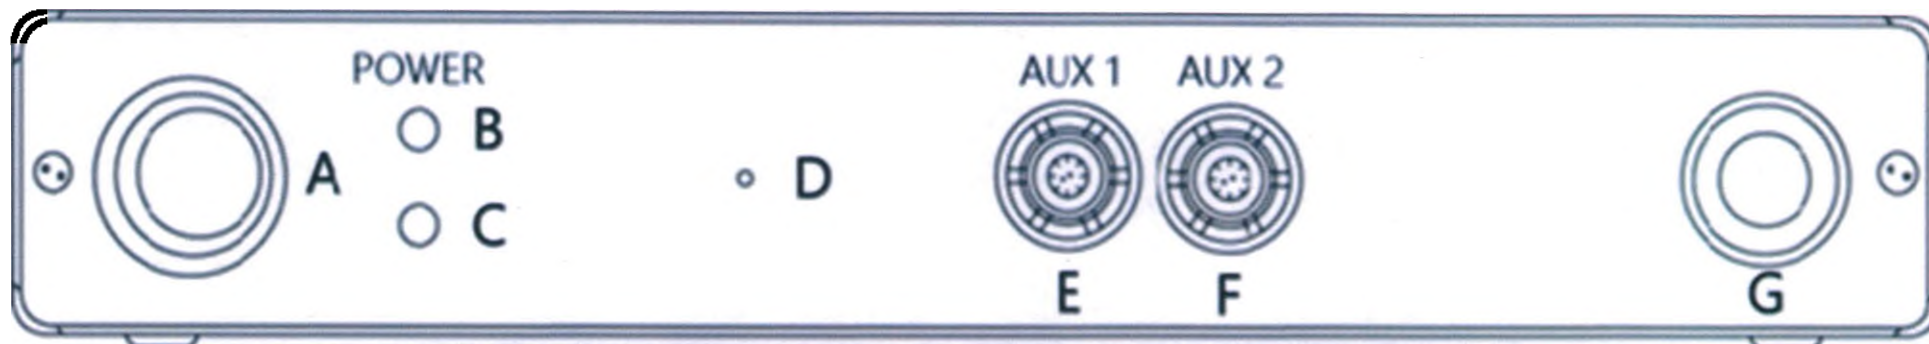




77. Датчик многоцветный SpO₂, не более 3 шт.



78. Кабель для неинвазивного измерения давления, не более 3 шт.



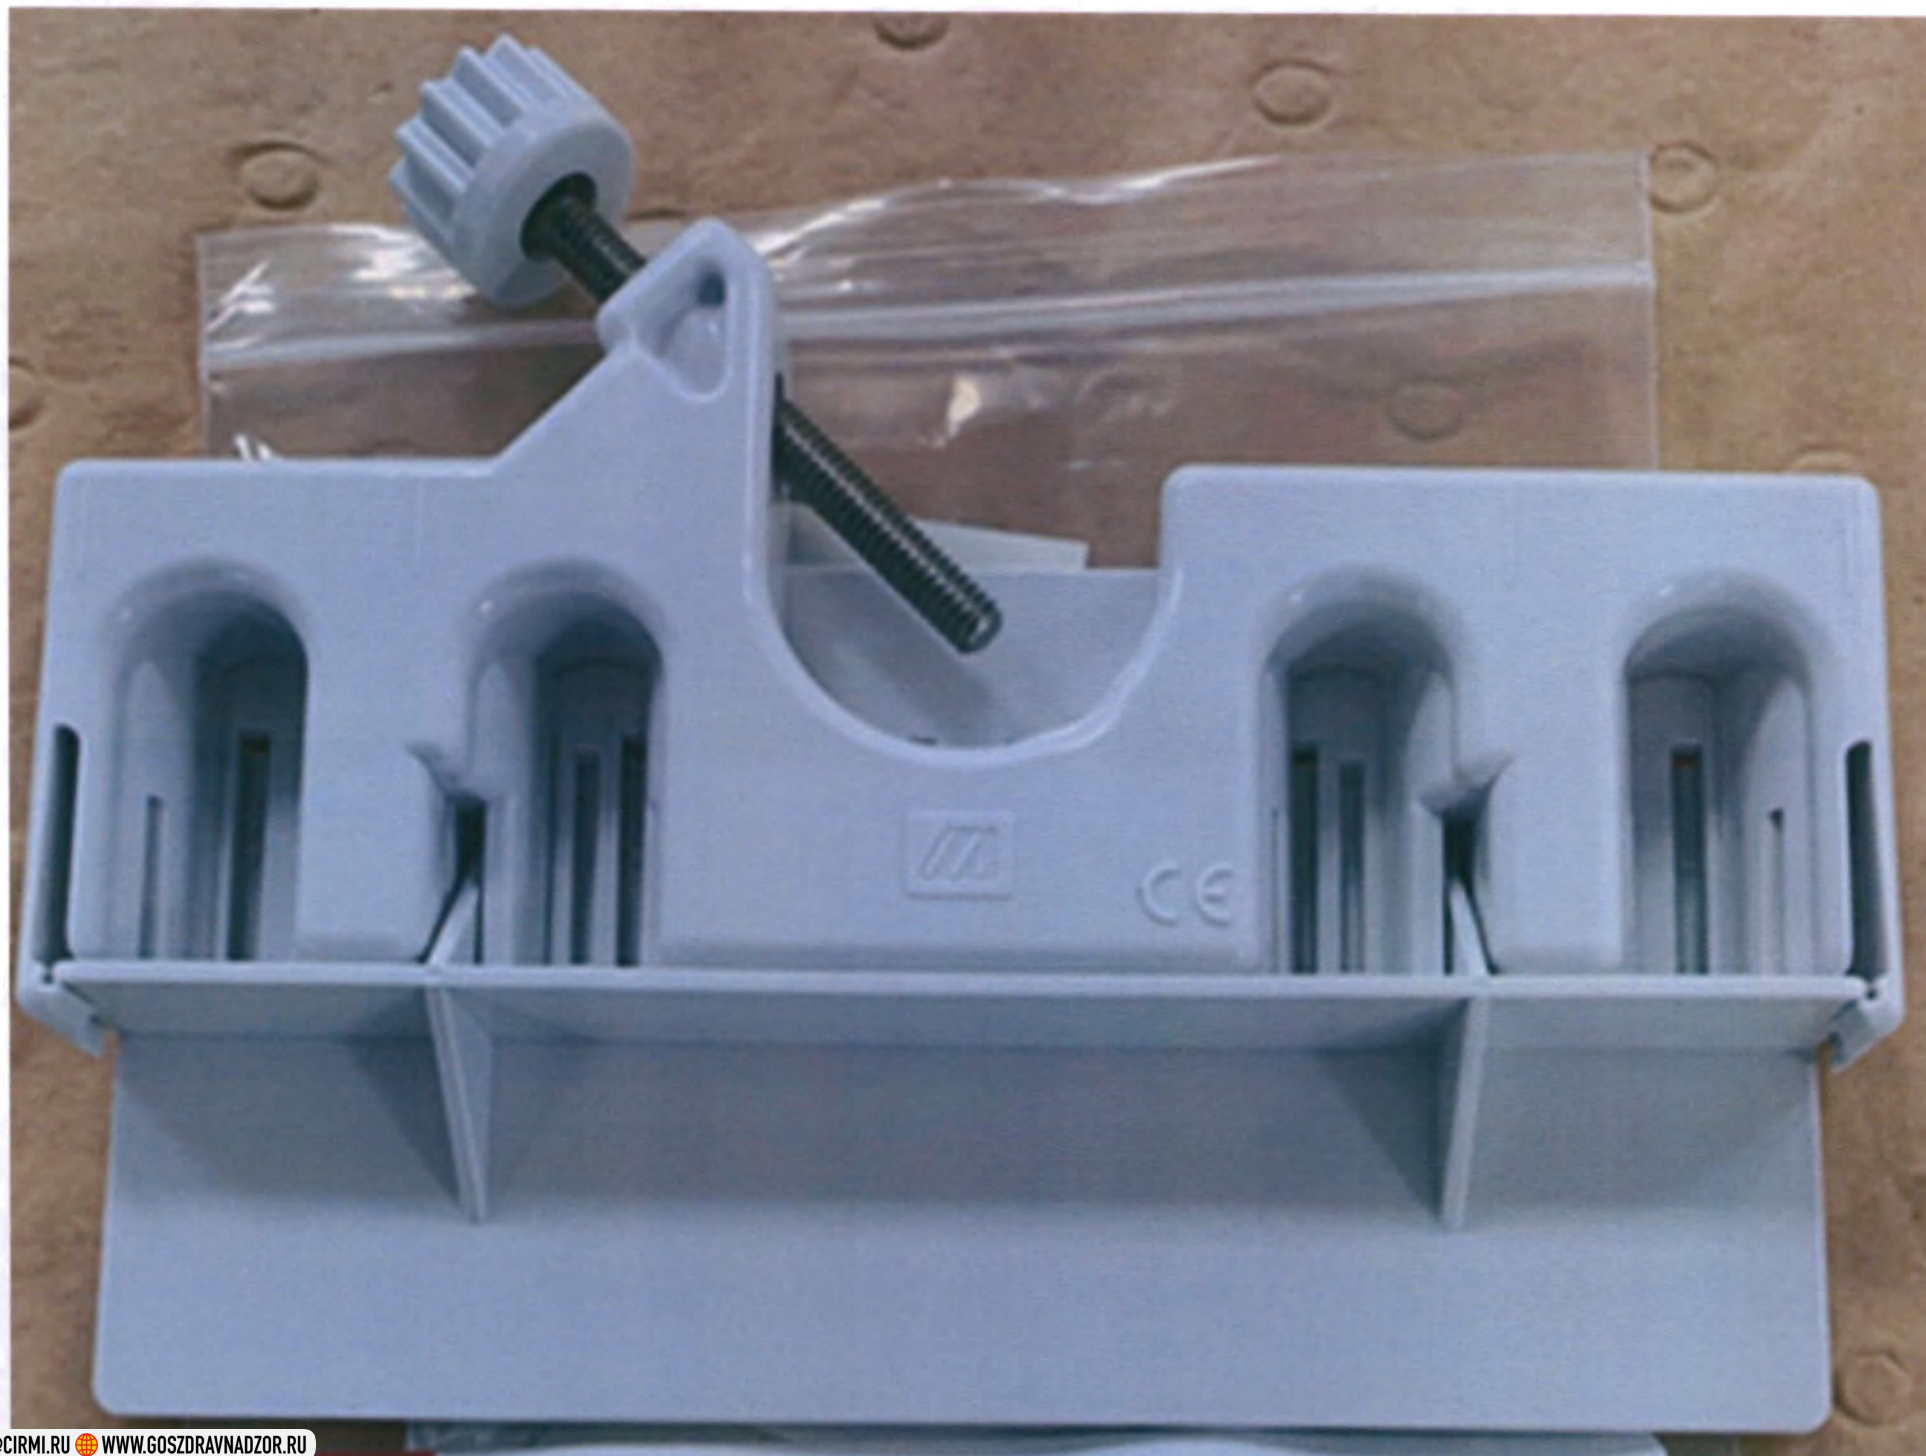

80. Комплект принадлежностей для большого монитора (система видеопередачи для операционной).



Подставка



Передатчик DVI 1



Передатчик DVI 2



Блок питания для монитора с большим экраном




Сетевой концентратор


81. Боковые направляющие для подвесного устройства для мониторов.




82. Комплект для защиты от магнитных полей (магнитный экран) для 8-дюймового FPD

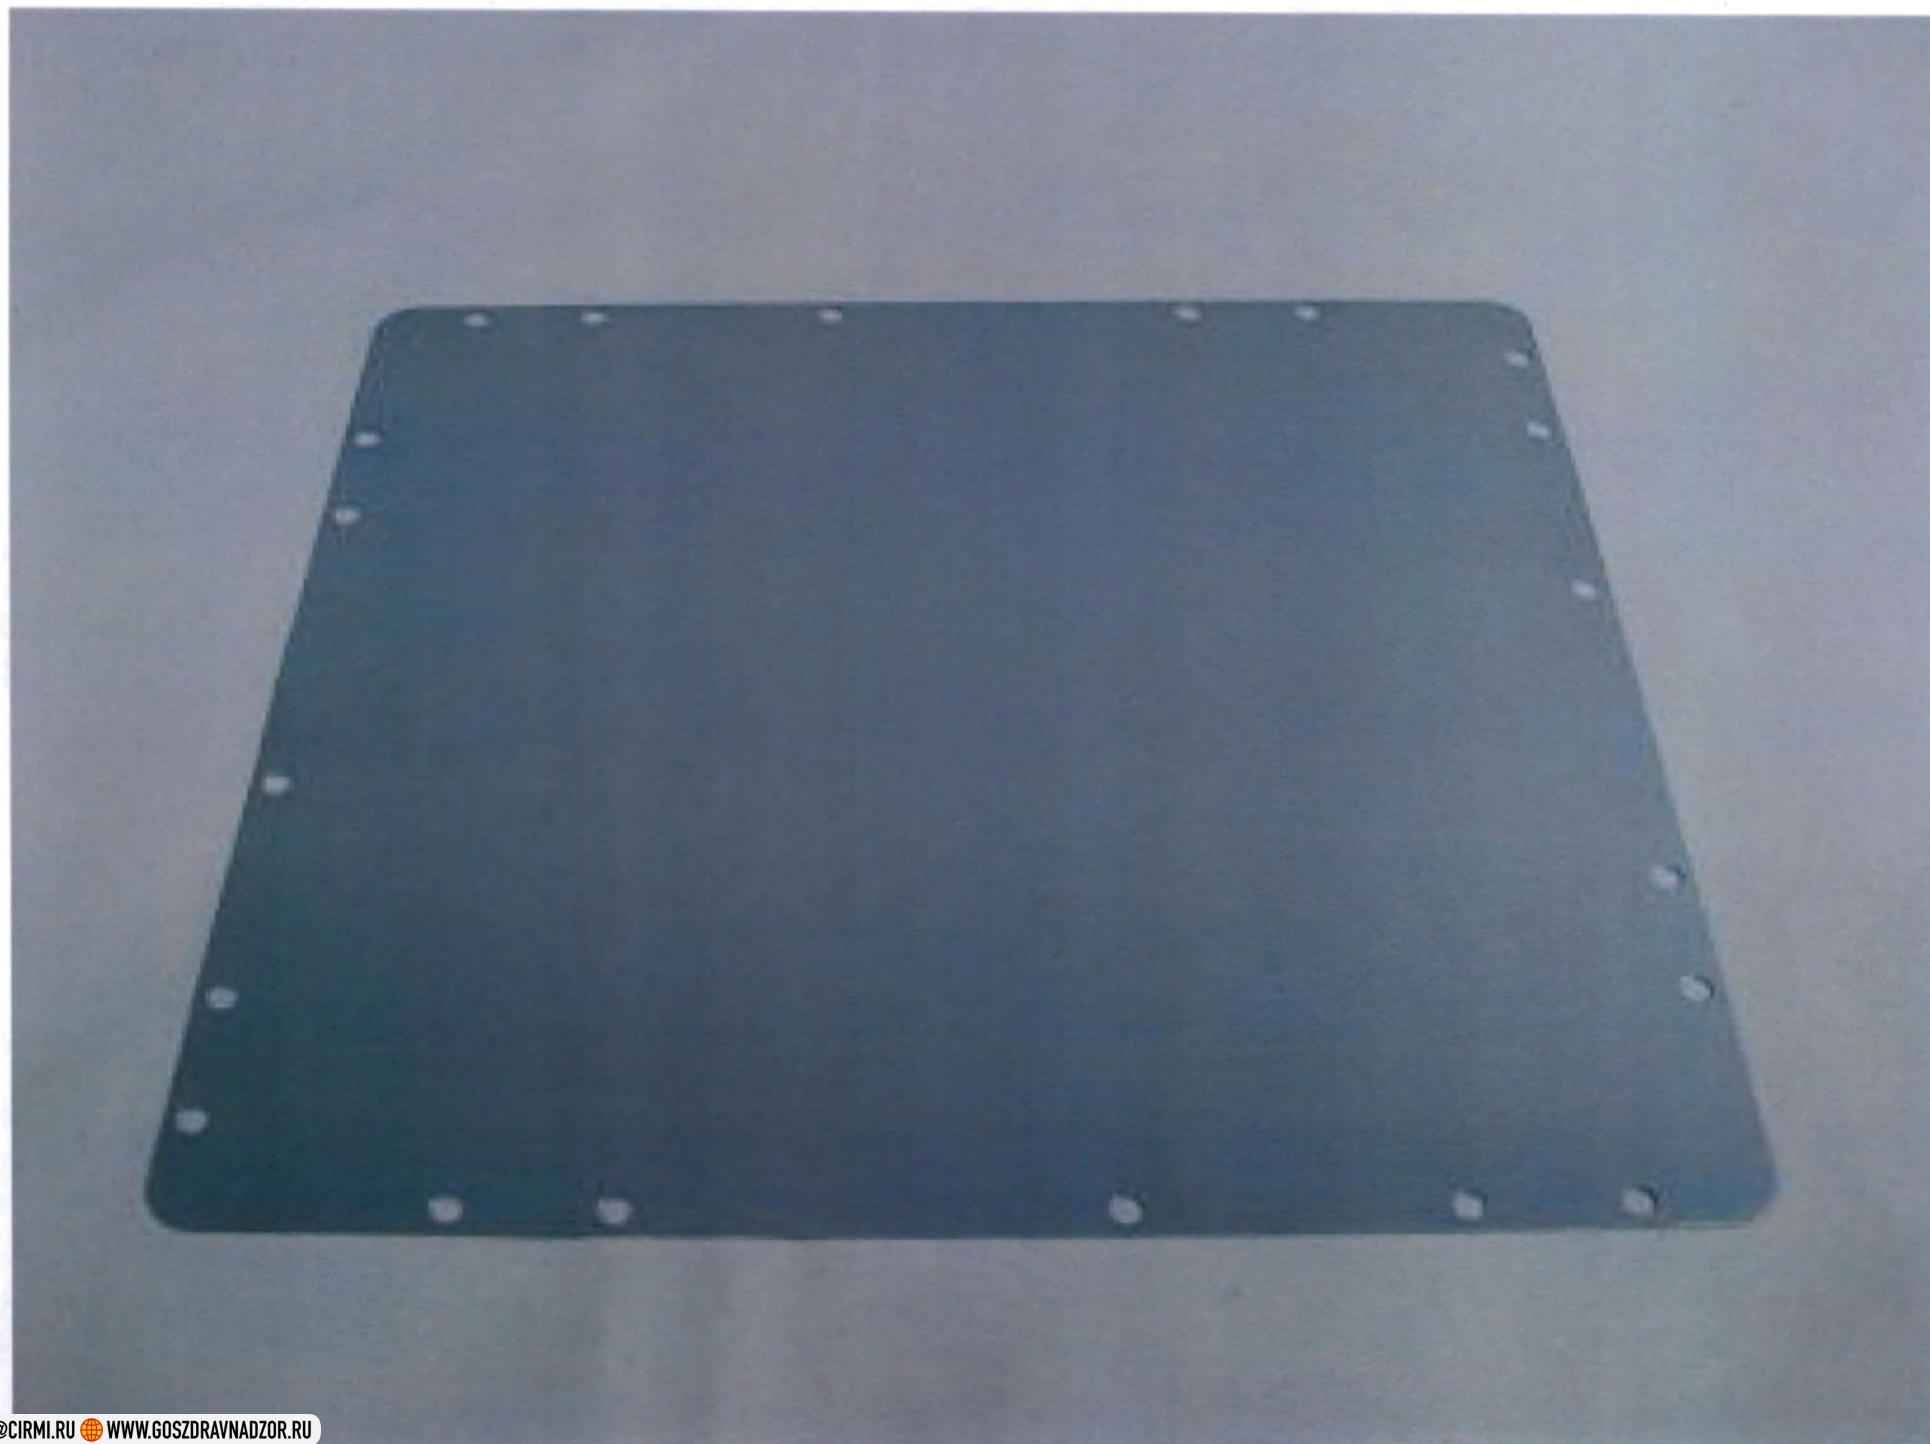

83. Комплект для противоположной стороны вывода кабеля.

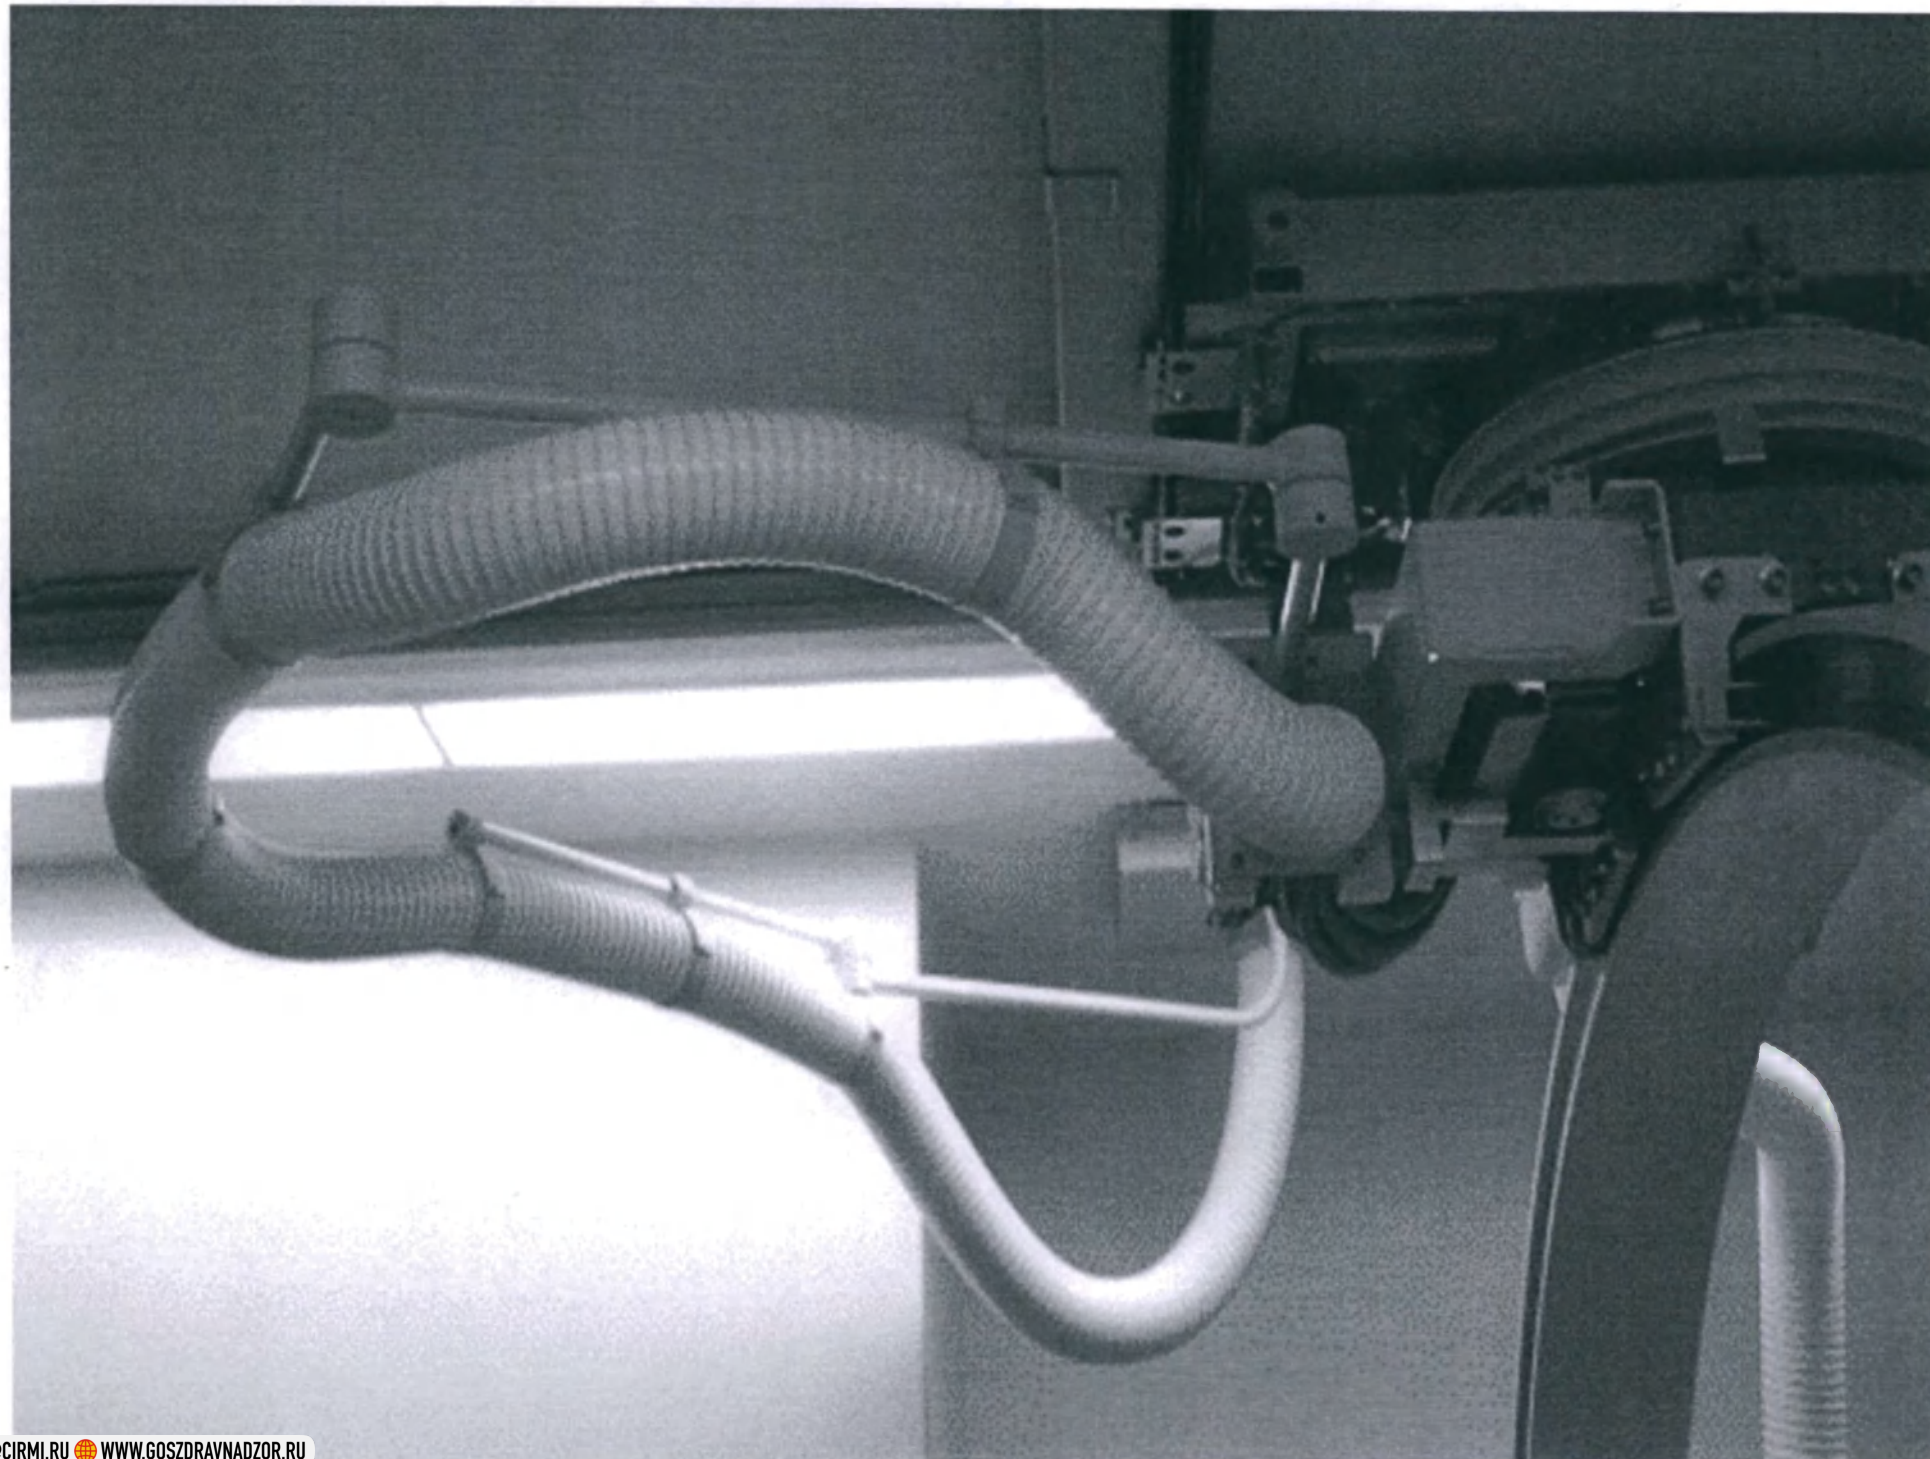


84. Комплект фиксатора поворота опорной колонны (для CAS-880A)

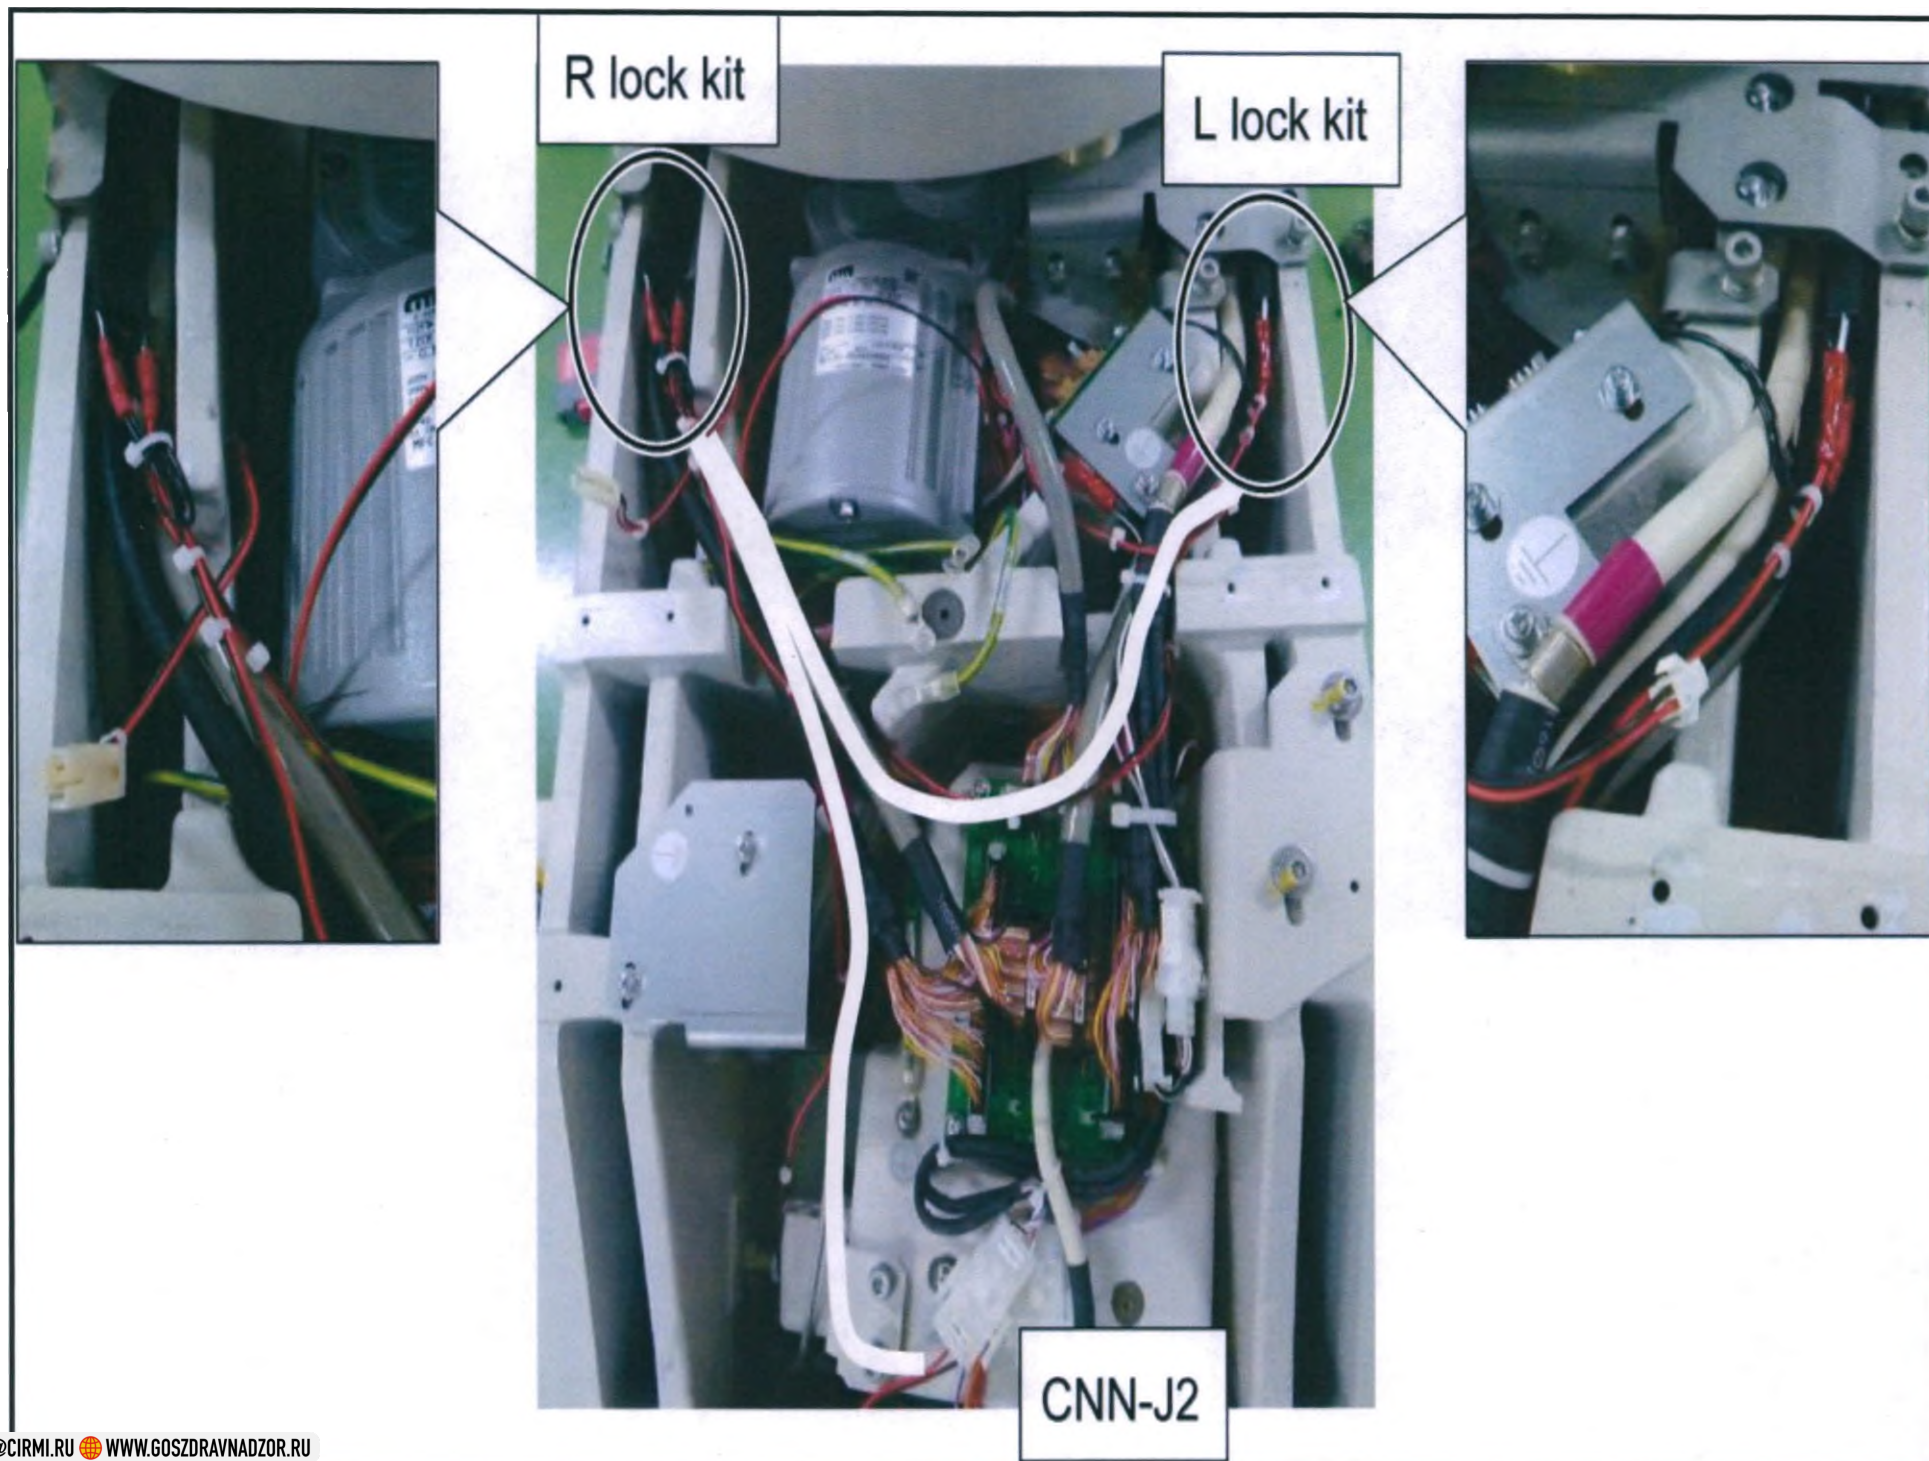



Комплект встроен
внутрь
САТ-850В/В1

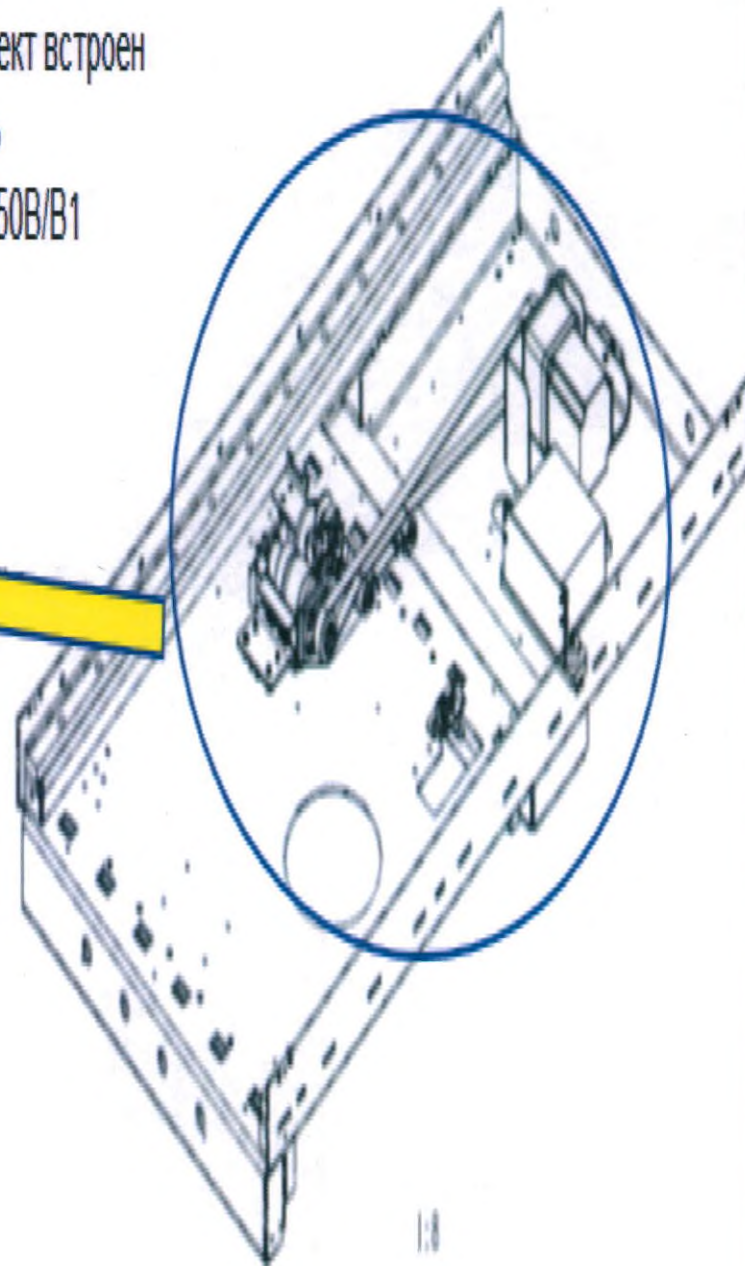

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - программное обеспечение основное - 1 шт.

Study List

Search: Searching default archive for Modality Any Study Date Any Status any

Status	Patient Name	Patient ID	Sex	Modality	# Images	Study Date/Time	Accession #	Study Description
	Endobulbar Plan	20040428	F	CT	762	08 Apr 2014 09:17		
	40CT SACRAL VERTEBRALITY	0A2V-603	F	CT	3236	24 Mar 2016 13:03	VISION	
	CHEST CT/PE, SURE IV	0A2V-TUL	F	CT	2503	07 Feb 2016 17:09	ONE_VISION	
	CHEST CT/PE, SURE IV	0A2V-TUL	F	CT	2675	05 Feb 2016 22:28	ONE_VISION	
	CHEST CT/PE, SURE IV	0A2V-TUL	F	CT	3204	05 Feb 2016 15:08	ONE_VISION	
	DSA HEAD 151	3D-INFX...		XA, SA	1627	14 Dec 2015 07:29		3DINFX
	LG BOOH 068	LG-INFX...		XA, SA	1542	25 Aug 2015 13:36		3DINFX
	LG BOOH 068	LG-INFX...		XA	164	25 Aug 2015 09:58		3DINFX
	CAA	0502777	M	XA	1624	08 Aug 2015 08:56	2005041706	
	MAPCA			CT	1807	01 May 2015 14:28		CTA
	VINE, MELCOY	12545		CT	4402	01 May 2015 12:54		Card Core CTA
	Brain CDR Subtraction	MCA Ar...	F	CT, SA	722	01 Apr 2015 26:58	ONE_VISION	CT Angiogram C...
	MH AO PULM	12577		SA	124	18 Mar 2015 08:11		Card Cardiac P...
	CEREBRAL ANEURYSM	3D-INFX...		XA	513	11 Jun 2014 14:07	ABC	
	IT AND RETRACT CEMRA ONE PULM 80Y SPN	148-CE...	M	SA	1136	05 May 2014 15:28		
	3D DSA L-Vert-Aneurysm 905	3D DSA...	F	XA	1625	18 Feb 2014 07:06		
	3D DSA LICA Aneurysm 012	3D DSA...	F	XA	512	27 Jan 2014 08:02		

Last updated: 32m ago Total results: 25

Applications: Results: Study

3D 3D Window: Cerebral Aneurysm Analysis: Endobulbar Plan

CEREBRAL ANEURYSM | 3D-INFX-062 | 11 Jun 2014 14:07

Each: 30 List: 22 Images


Open

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: персональный компьютер - 1 шт.




86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - клавиатура - 1 шт.

003

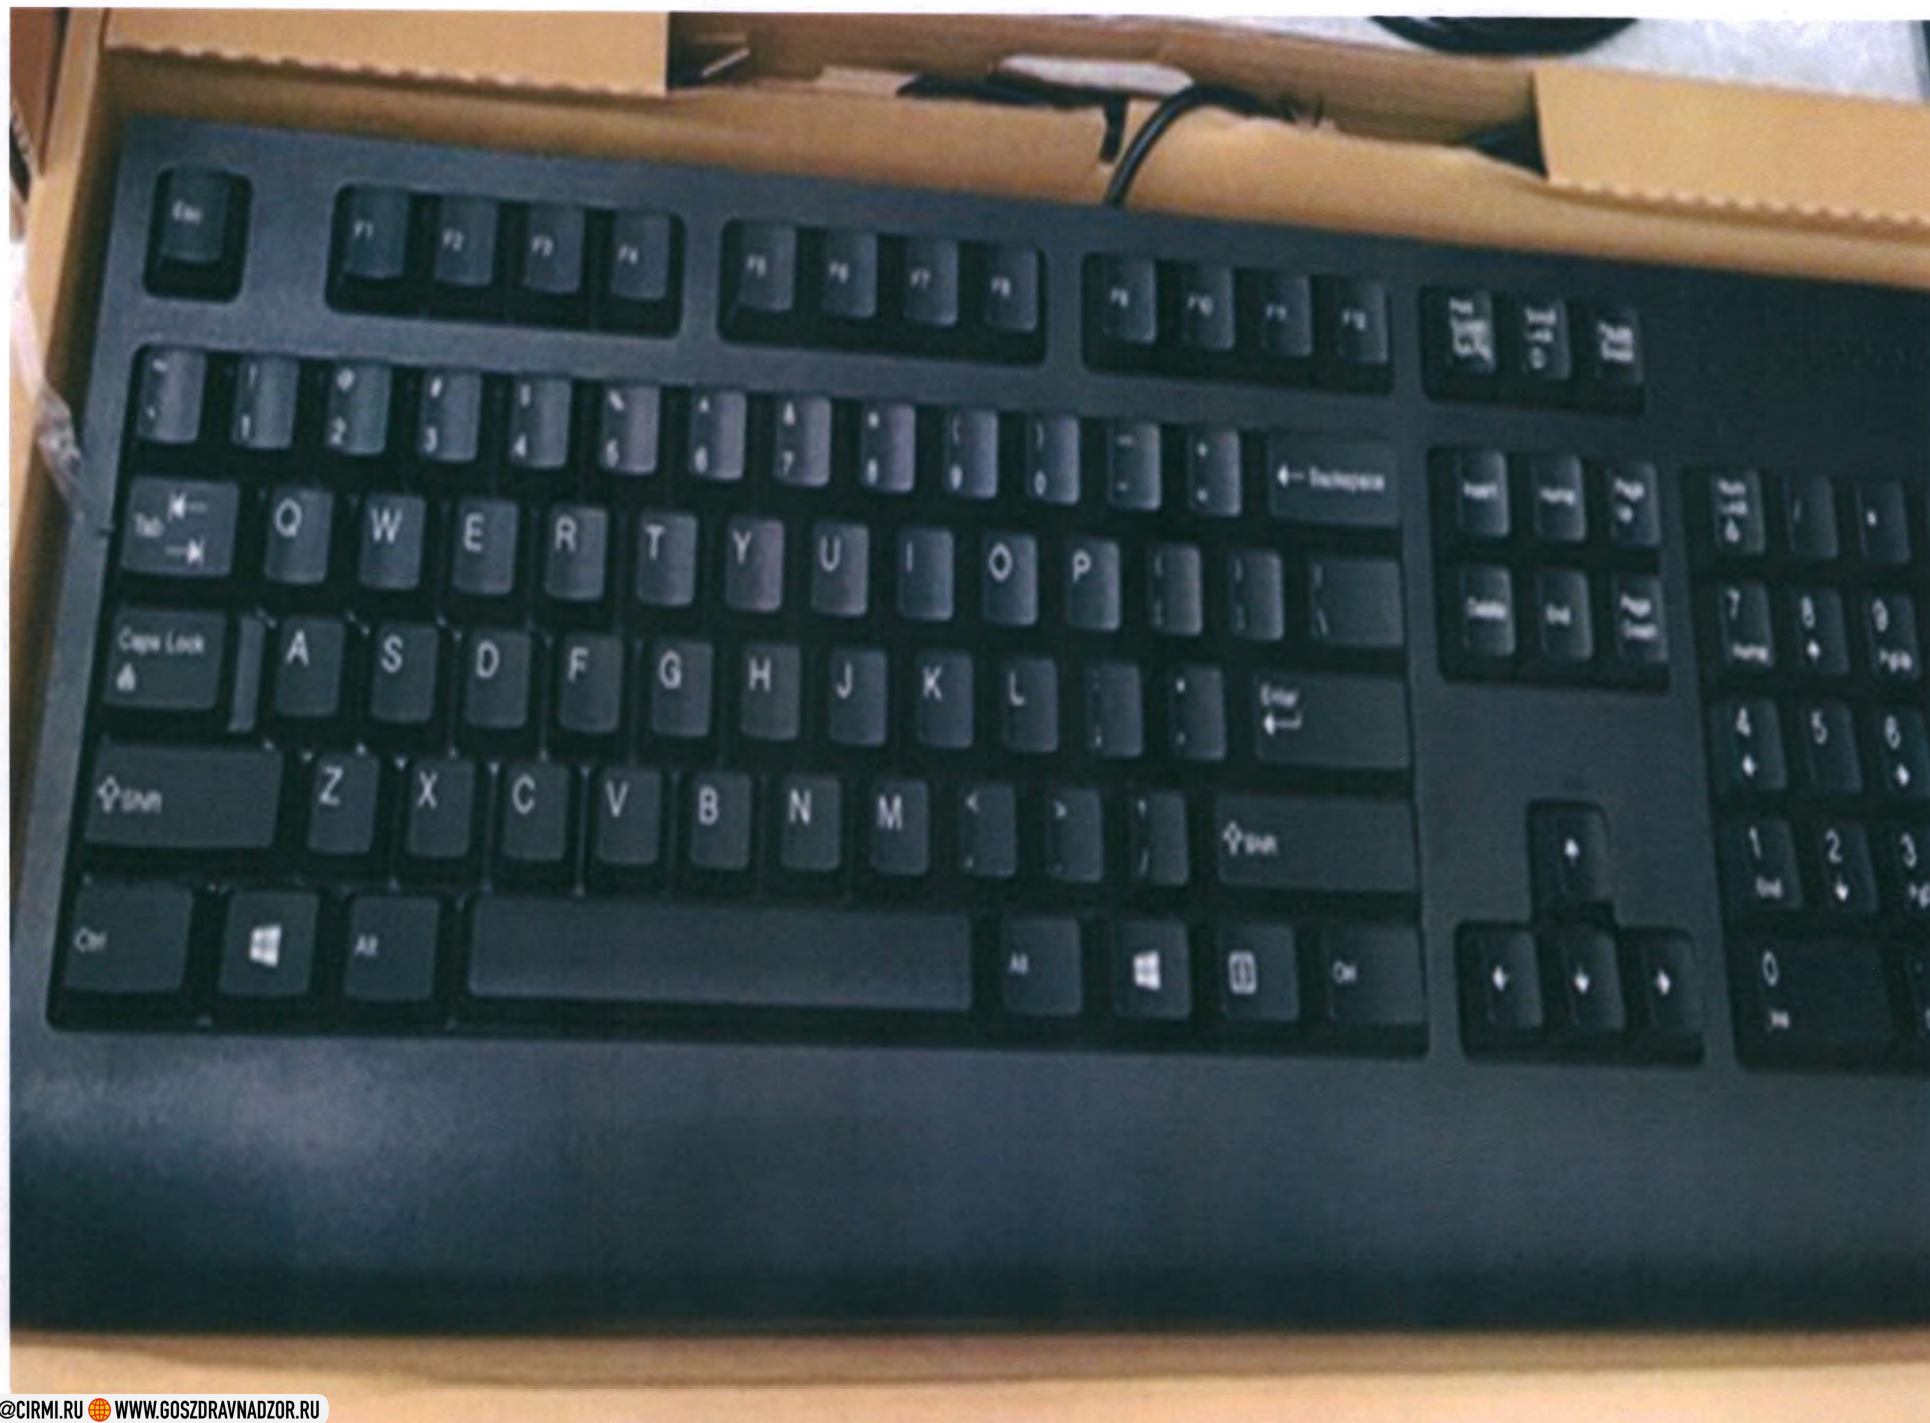

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - манипулятор «мышь» - 1 шт.

304

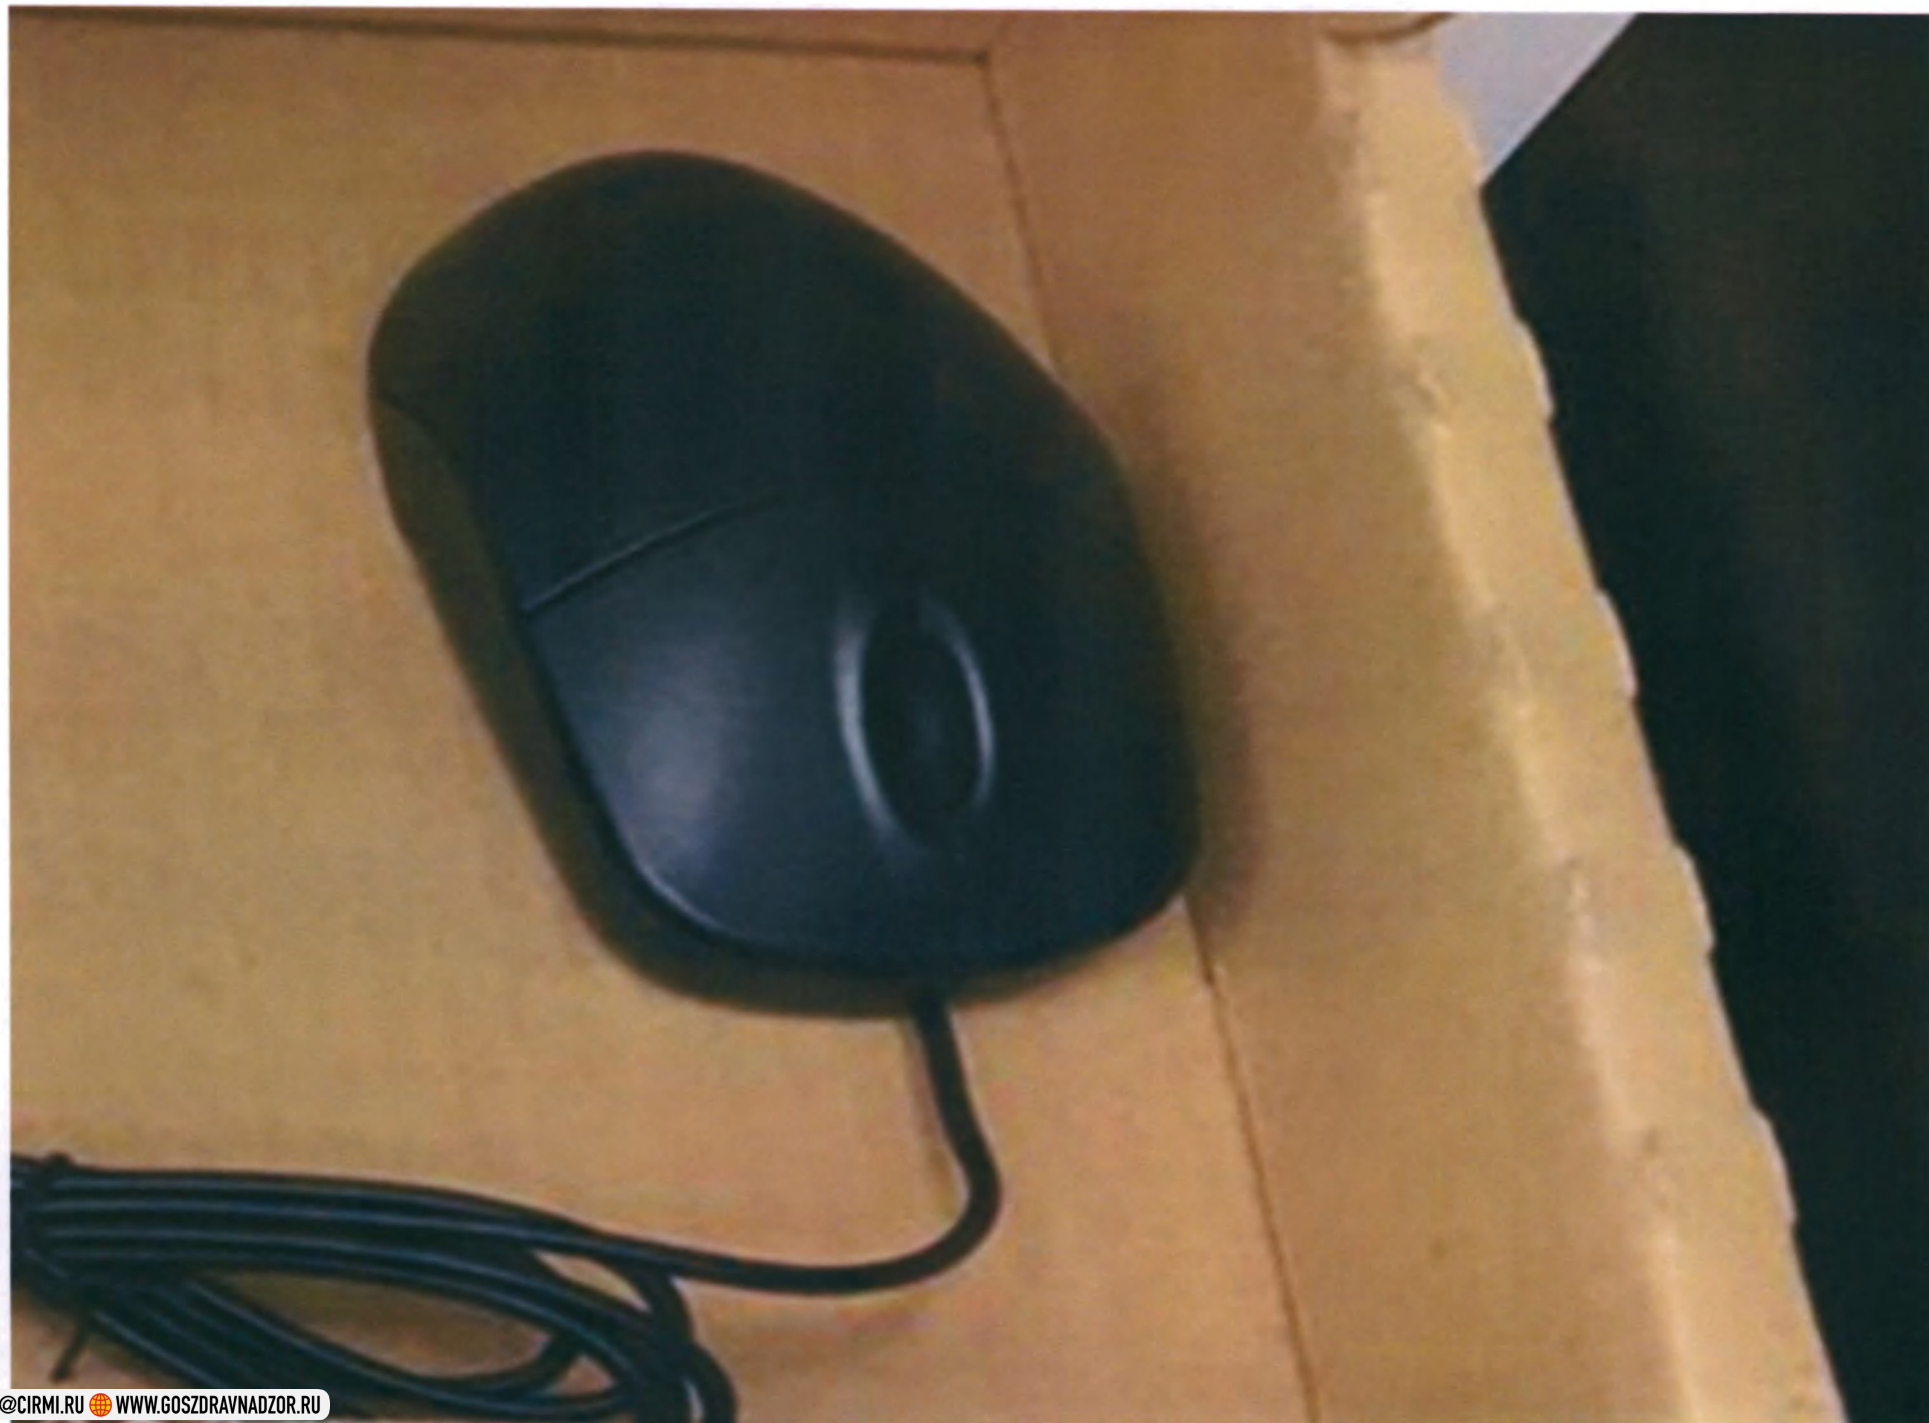


86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - концентратор - 1 шт.

000



86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - комплект кабелей - 4 шт.



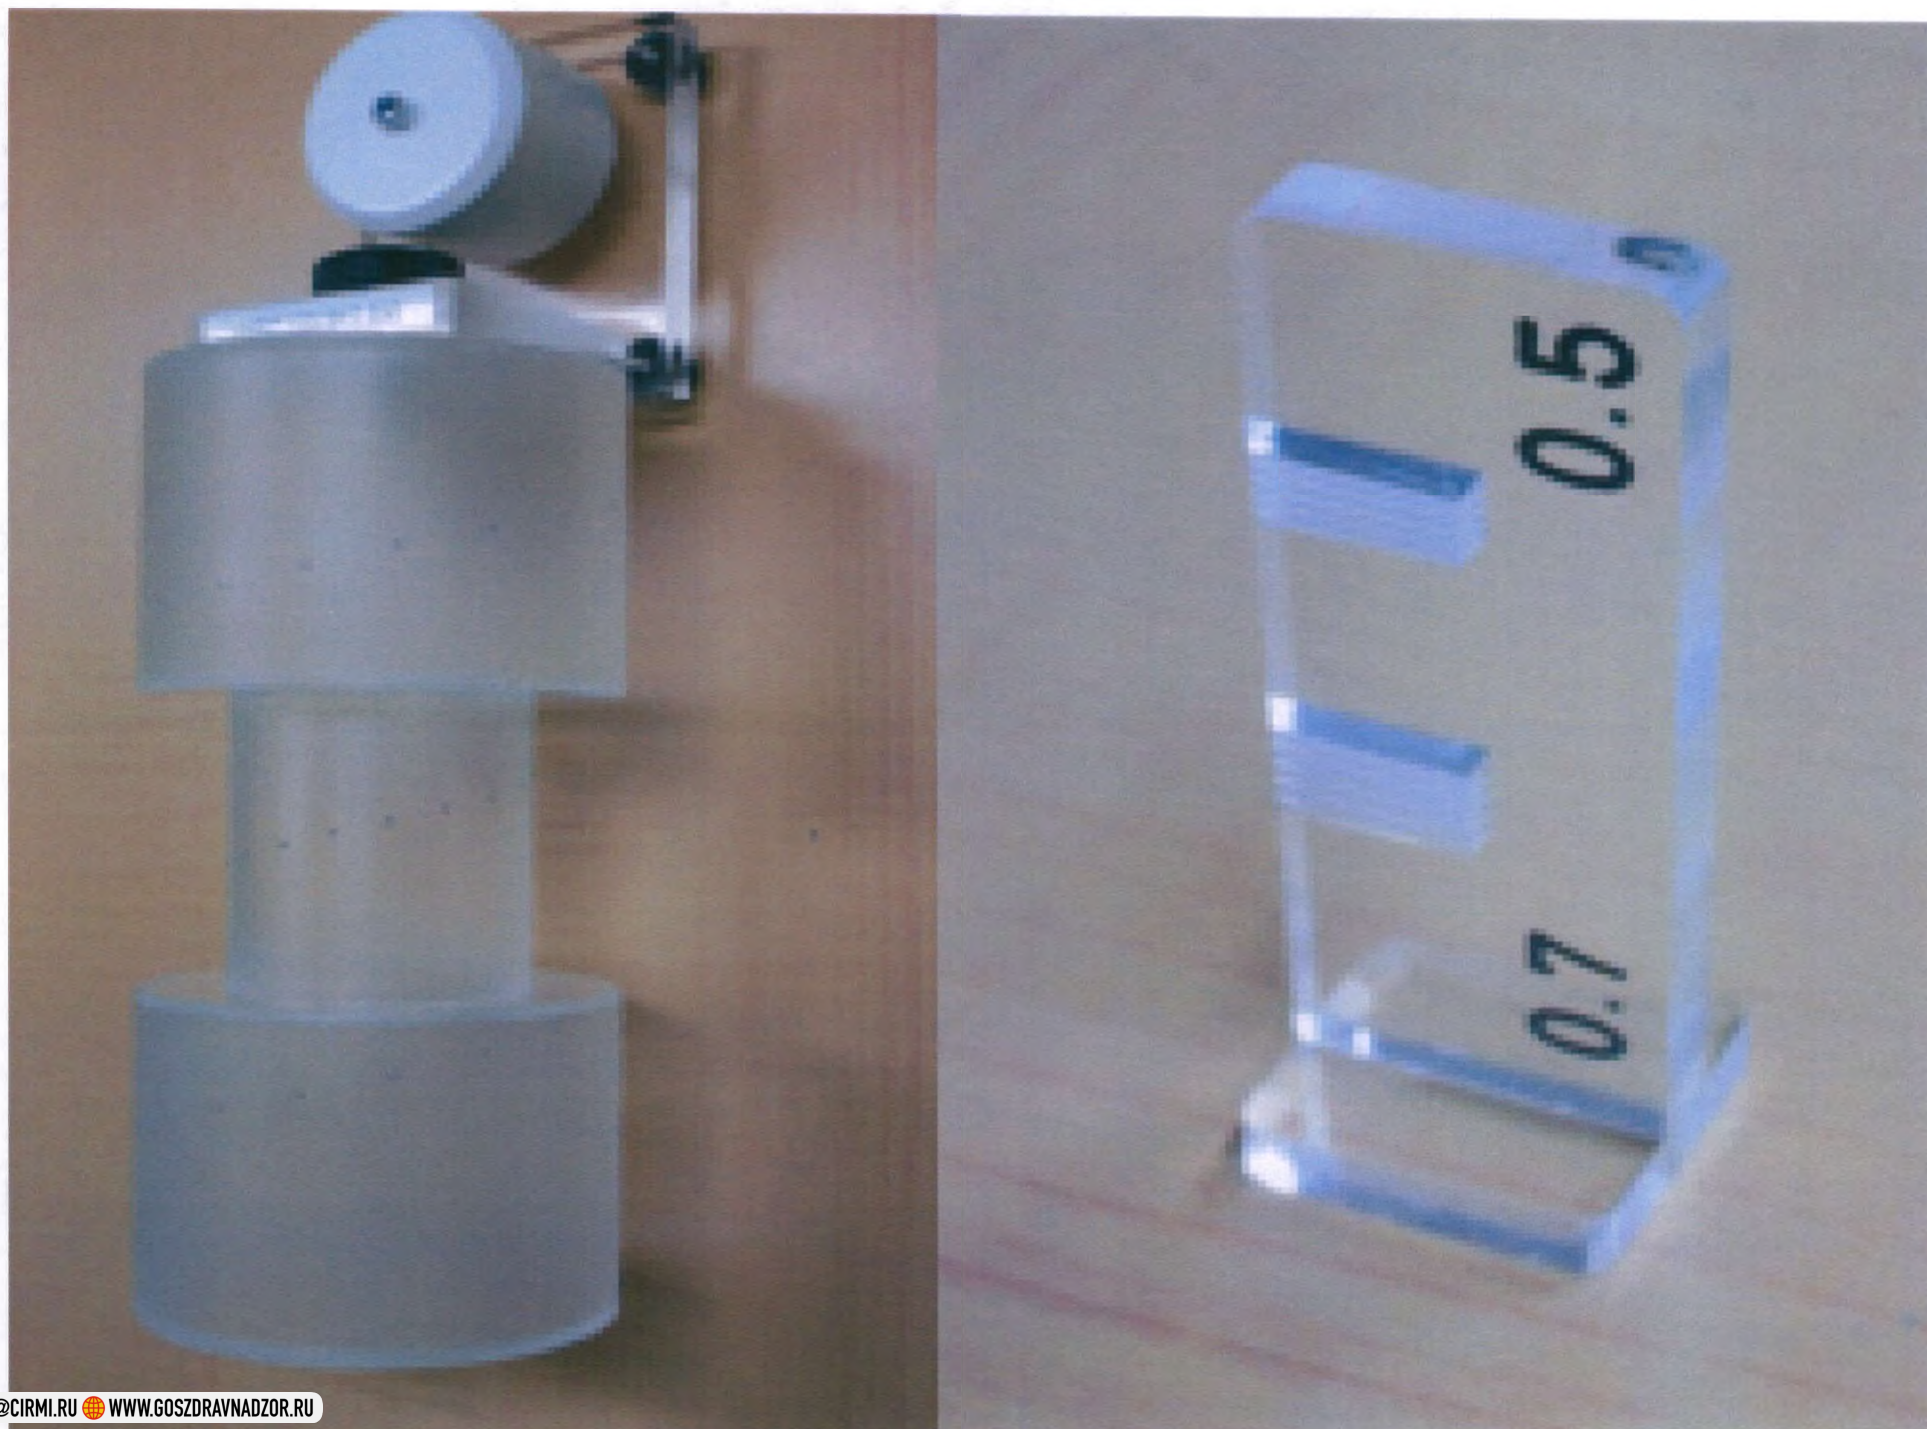

87. Монитор для Ангиографической рабочей станции - не более 4 шт.


000



88. Комплект дополнительного монитора для Ангиографической рабочей станции.



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет интерфейса для клинического анализа;

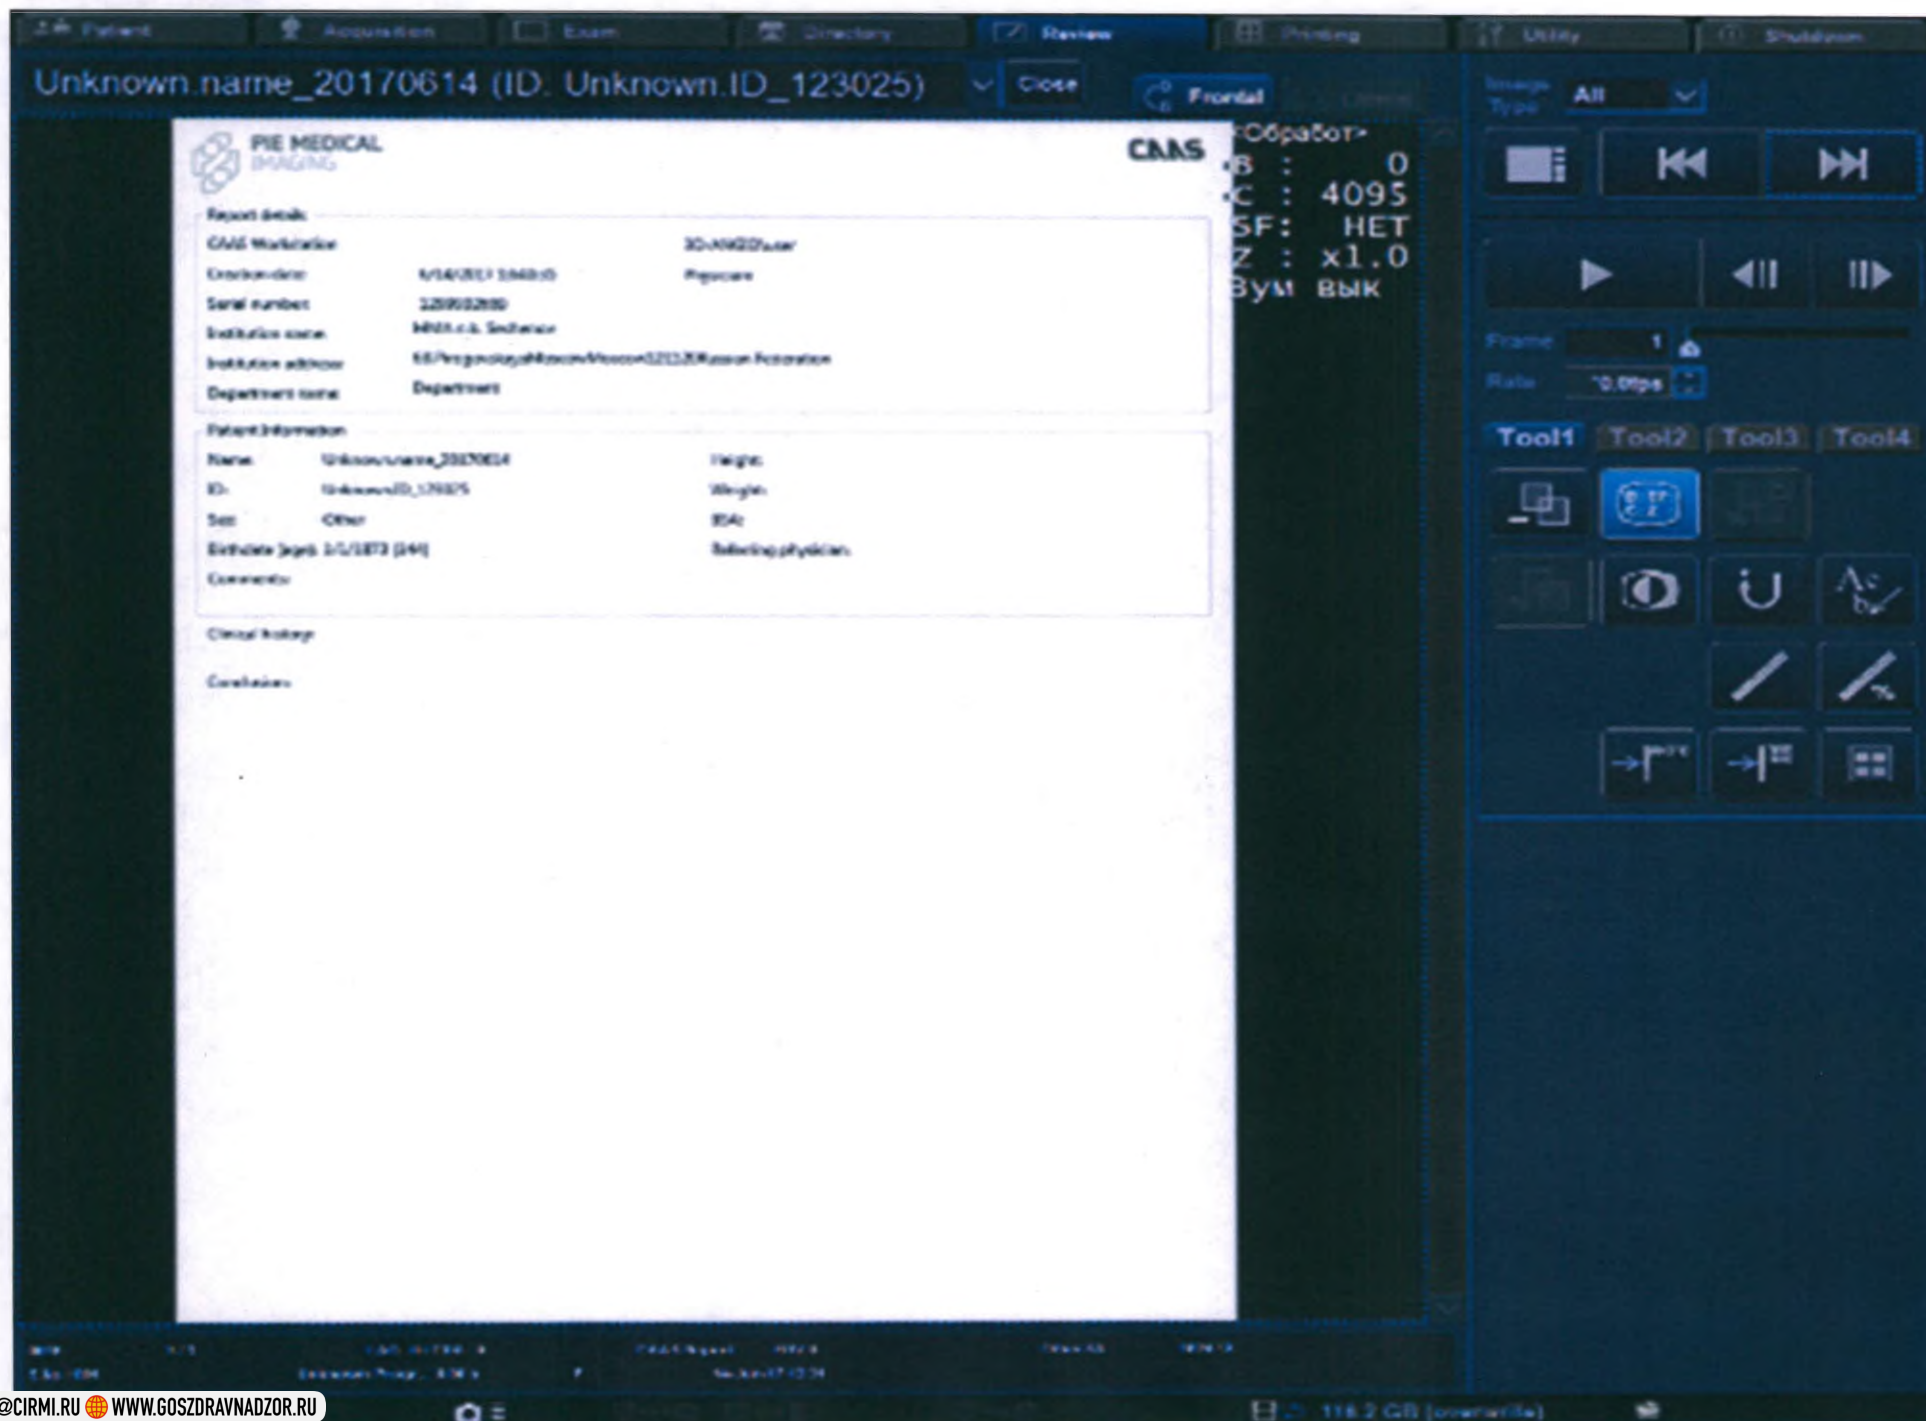

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QCA (анализ коронарных артерий)

CAAS Workstation 7.1.1 - 3Dadmin

PIE MEDICAL IMAGING CAAS

Report
☒ Header Page
 Viewing
☐ QCA 1

View
 Patient
 QCA
 Stent
 LVA
 RVA
 Report
 Save Report

DRIOENKOVA RAISA MIHAILOVNA - 15.06.2017

DRIOENKOVA RAISA MIHAILOVNA
 20.03.1948
 Female
 XA20170615114022

Report details

CAAS Workstation	3D-ANGIO/3Dadmin
Creation date:	15.06.2017 17:11:40
Serial number:	1299932669
Institution name:	MSMA n.b. Sechenov
Institution address:	68.PirogovskayaMoscowMoscow121120Russian Federation
Department name:	Department

Physician: -

Patient Information

Name:	DRIOENKOVA RAISA MIHAILOVNA	Height:	167 cm
ID:	37 478/2017	Weight:	110 kg
Sex:	Female	BSA:	2.16 m ²
Birthdate (age):	20.03.1948 (69)	Referring physician:	


Comments:

Clinical history:

Conclusion:

CAAS Workstation 7.1.1 1 / 2

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QVA (анализ сосудов)

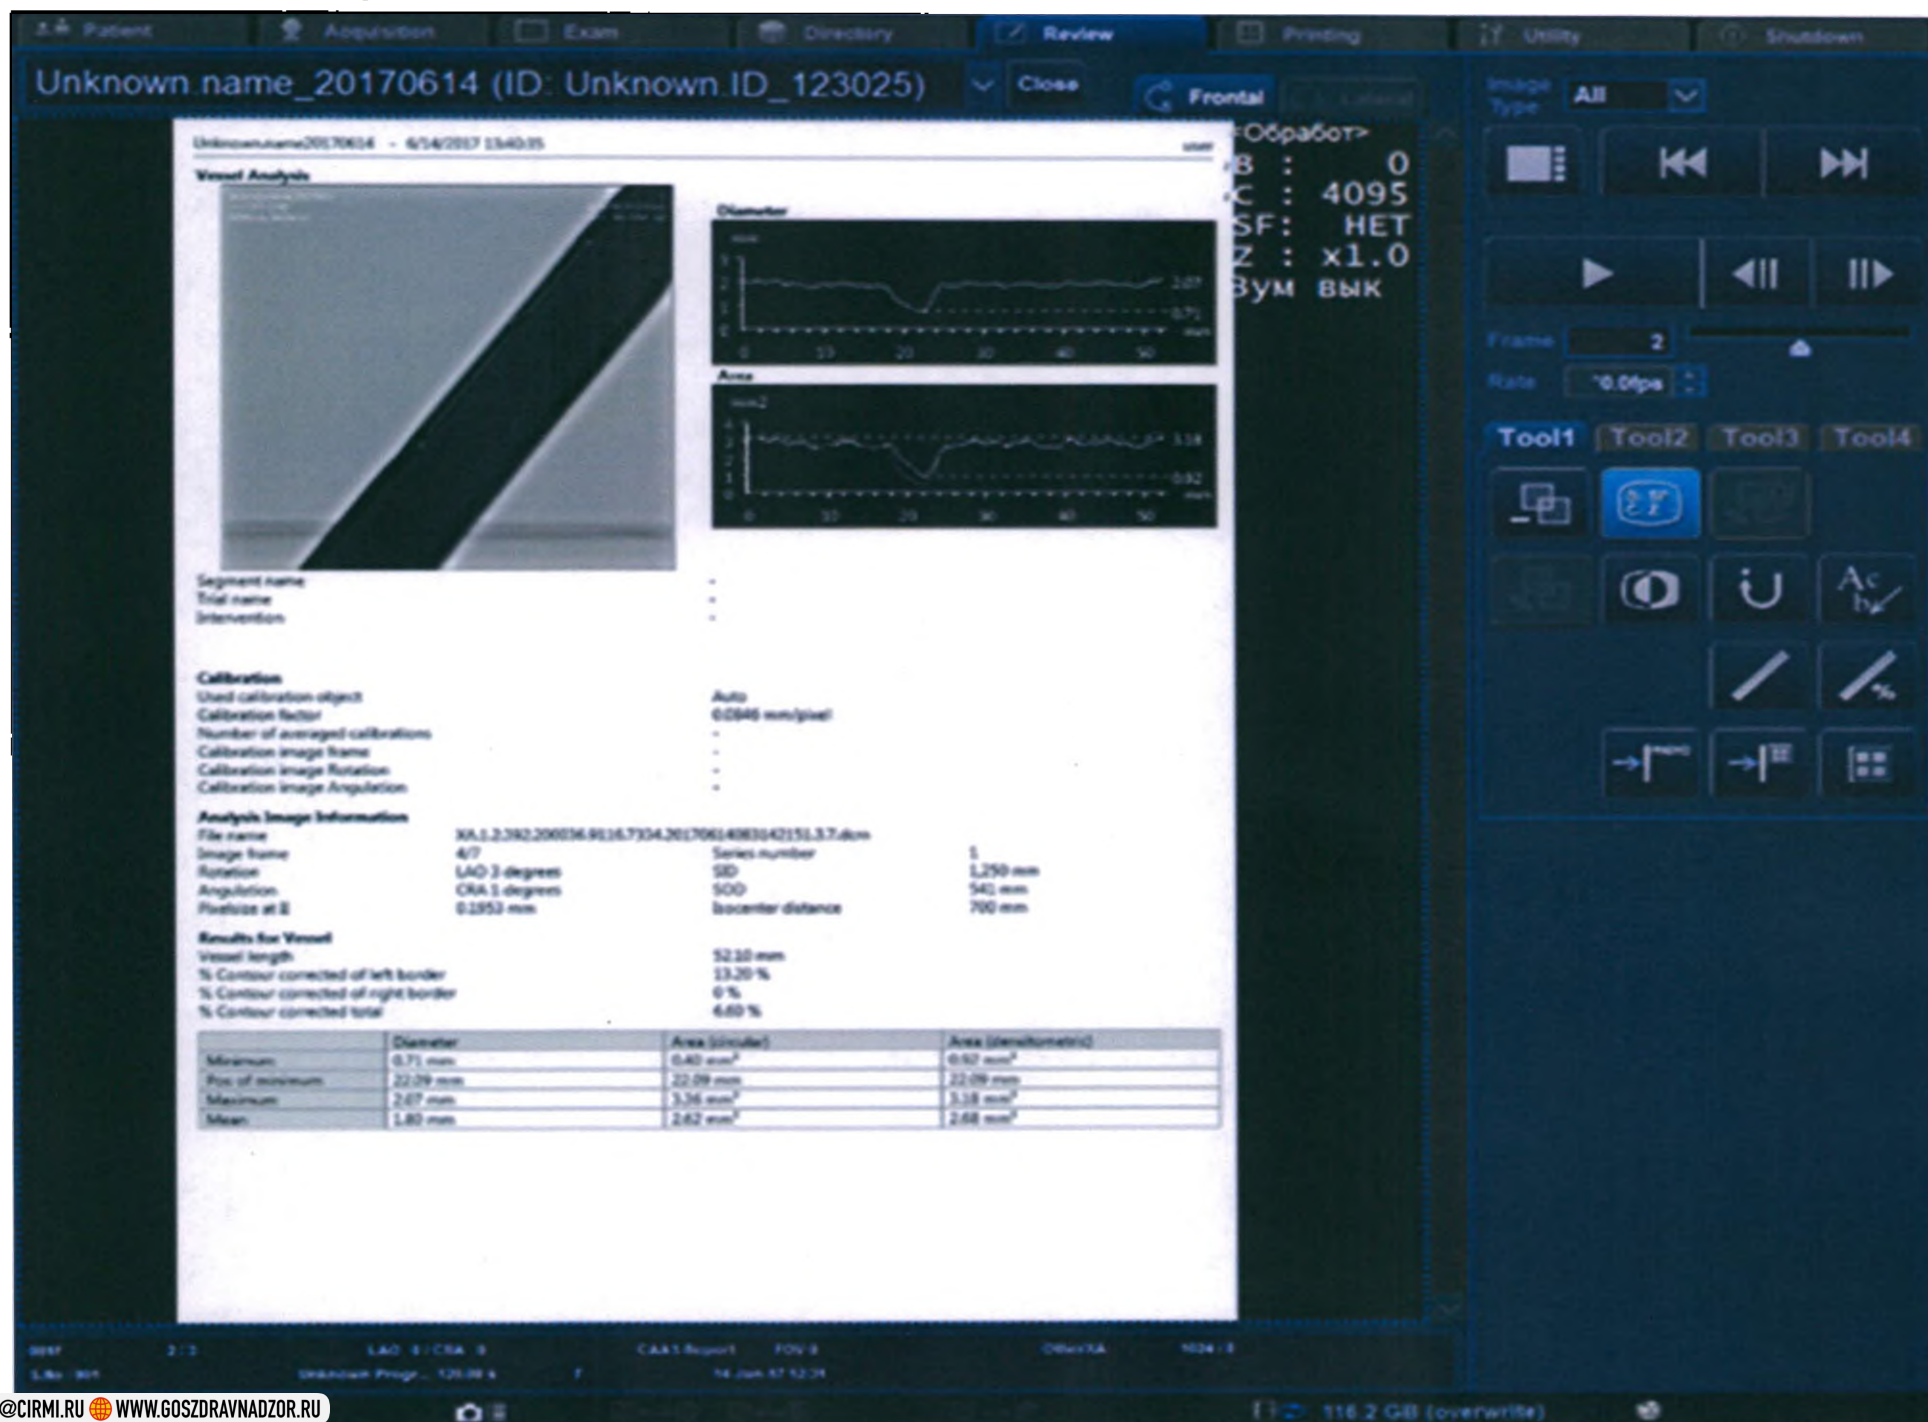

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа LVA (анализ левого желудочка)

CAAS Workstation 7.1.1 - 3DAdmin

Hide image ribbon

View

Hide report window

Report

Header Page

Viewing

QCA 1

PIE MEDICAL IMAGING

CAAS

Report details

CAAS Workstation	3D-ANGIO3DAdmin
Creation date	15.06.2017 17:11:40
Physician	-
Serial number	1299932669
Institution name	MMA n.b. Sechenov
Institution address	68.PirogovskayaMoscowMoscow121120Russian Federation
Department name	Department

Patient Information

Name	DROENKOVA RAISA MIHAILOVNA	Height	167 cm
ID	37 478/2017	Weight	110 kg
Sex	Female	BSA	2.16 m ²
Birthdate (age)	20.03.1948 (69)	Referring physician	

Comments

Clinical History

Conclusion

CAAS Workstation 7.1.1

1 / 2

CAAS


DROENKOVA RAISA MIHAILOVNA

20.03.1948


Female

XA20170615114022


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа LVA-ВР (двухплоскостной анализ левого желудочка)

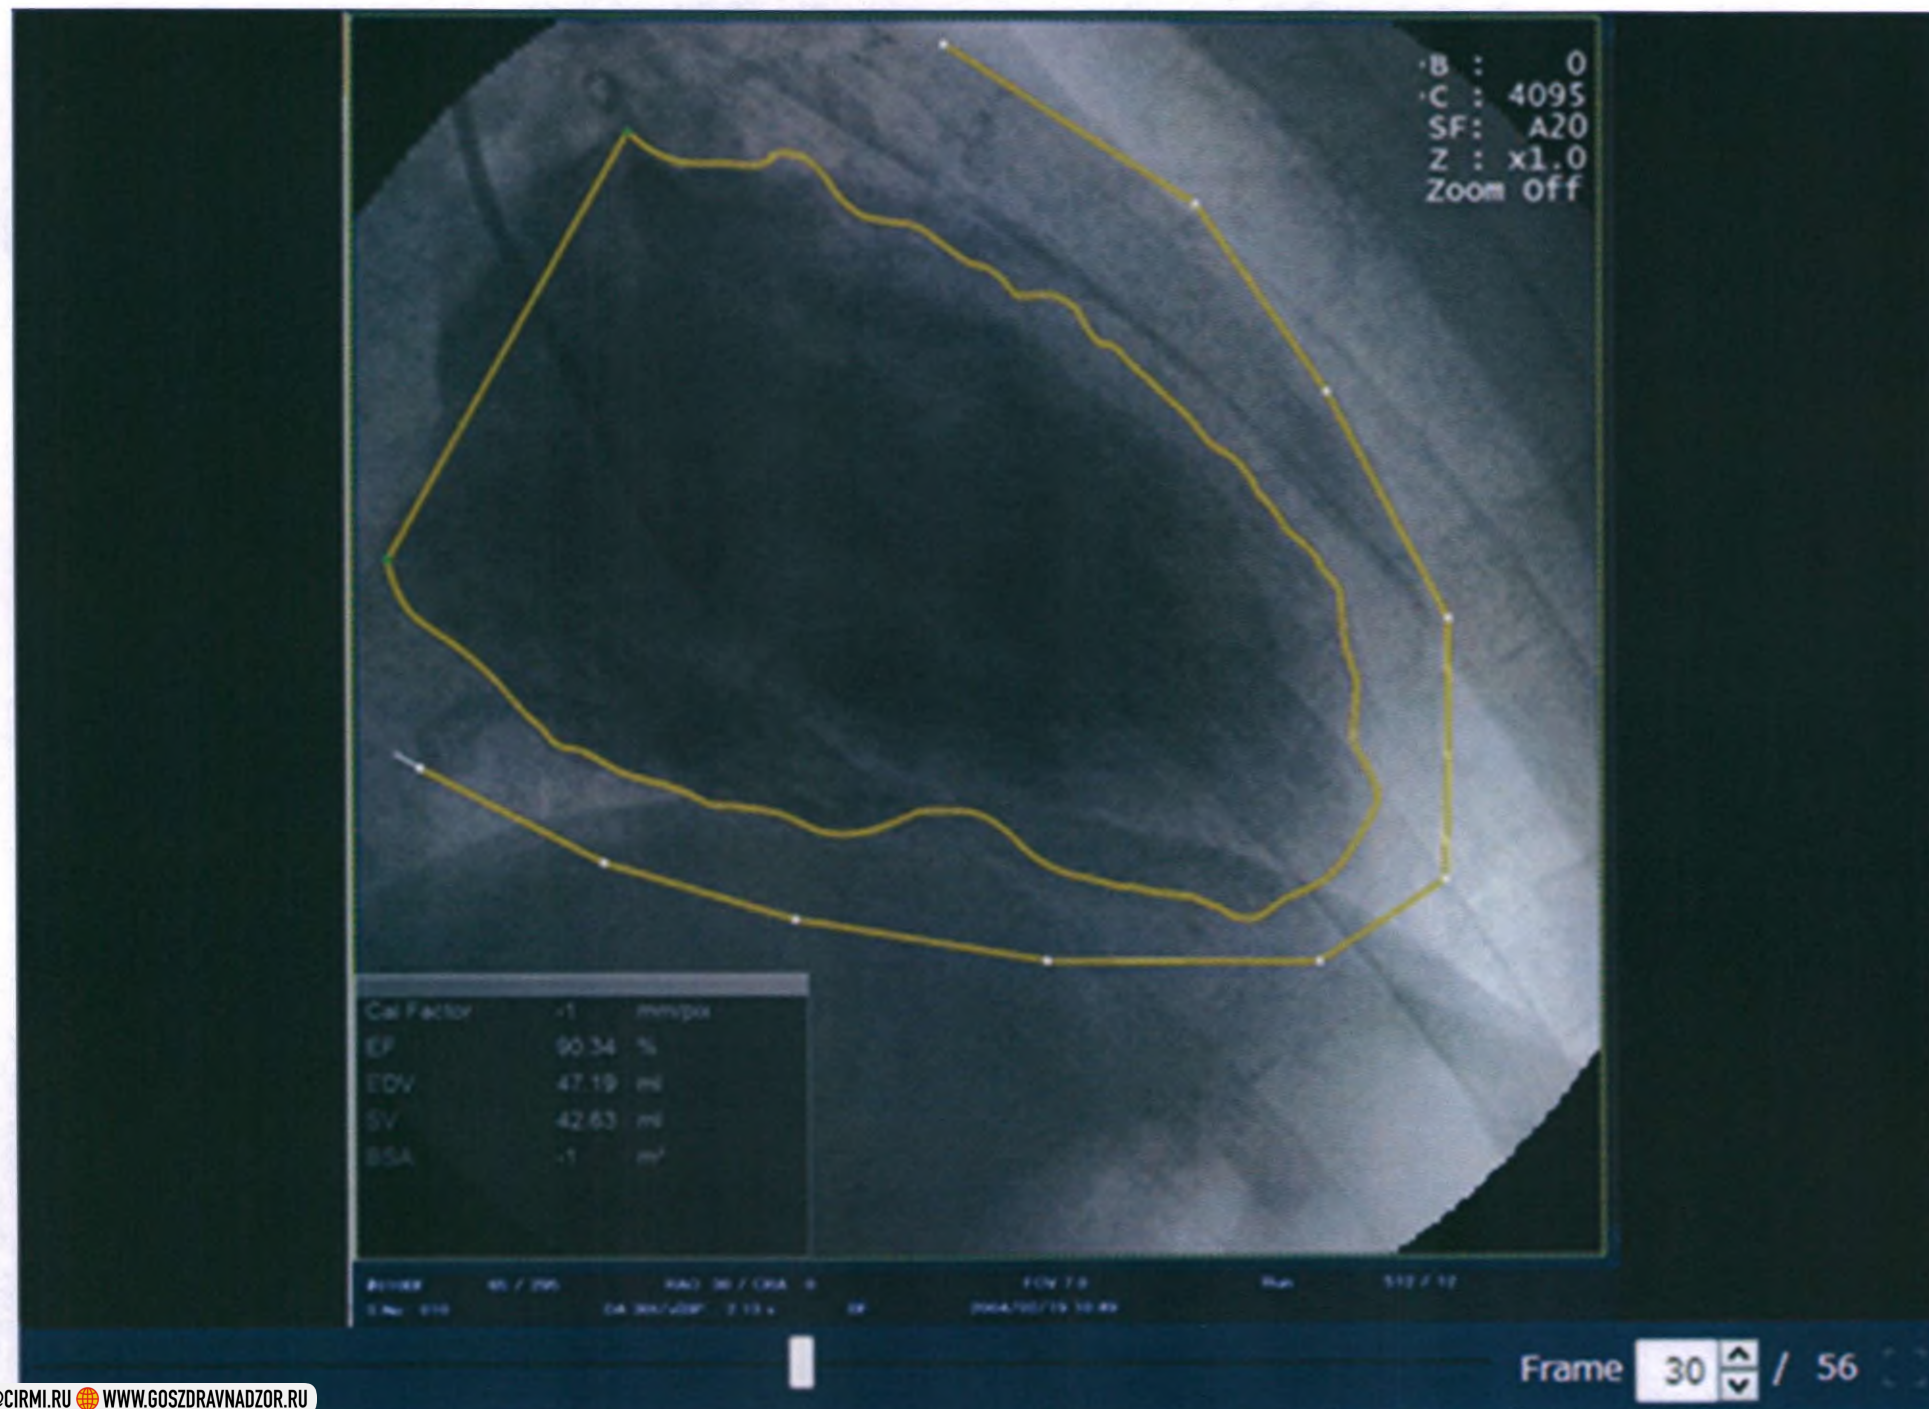


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа RVA (анализ правого желудочка)

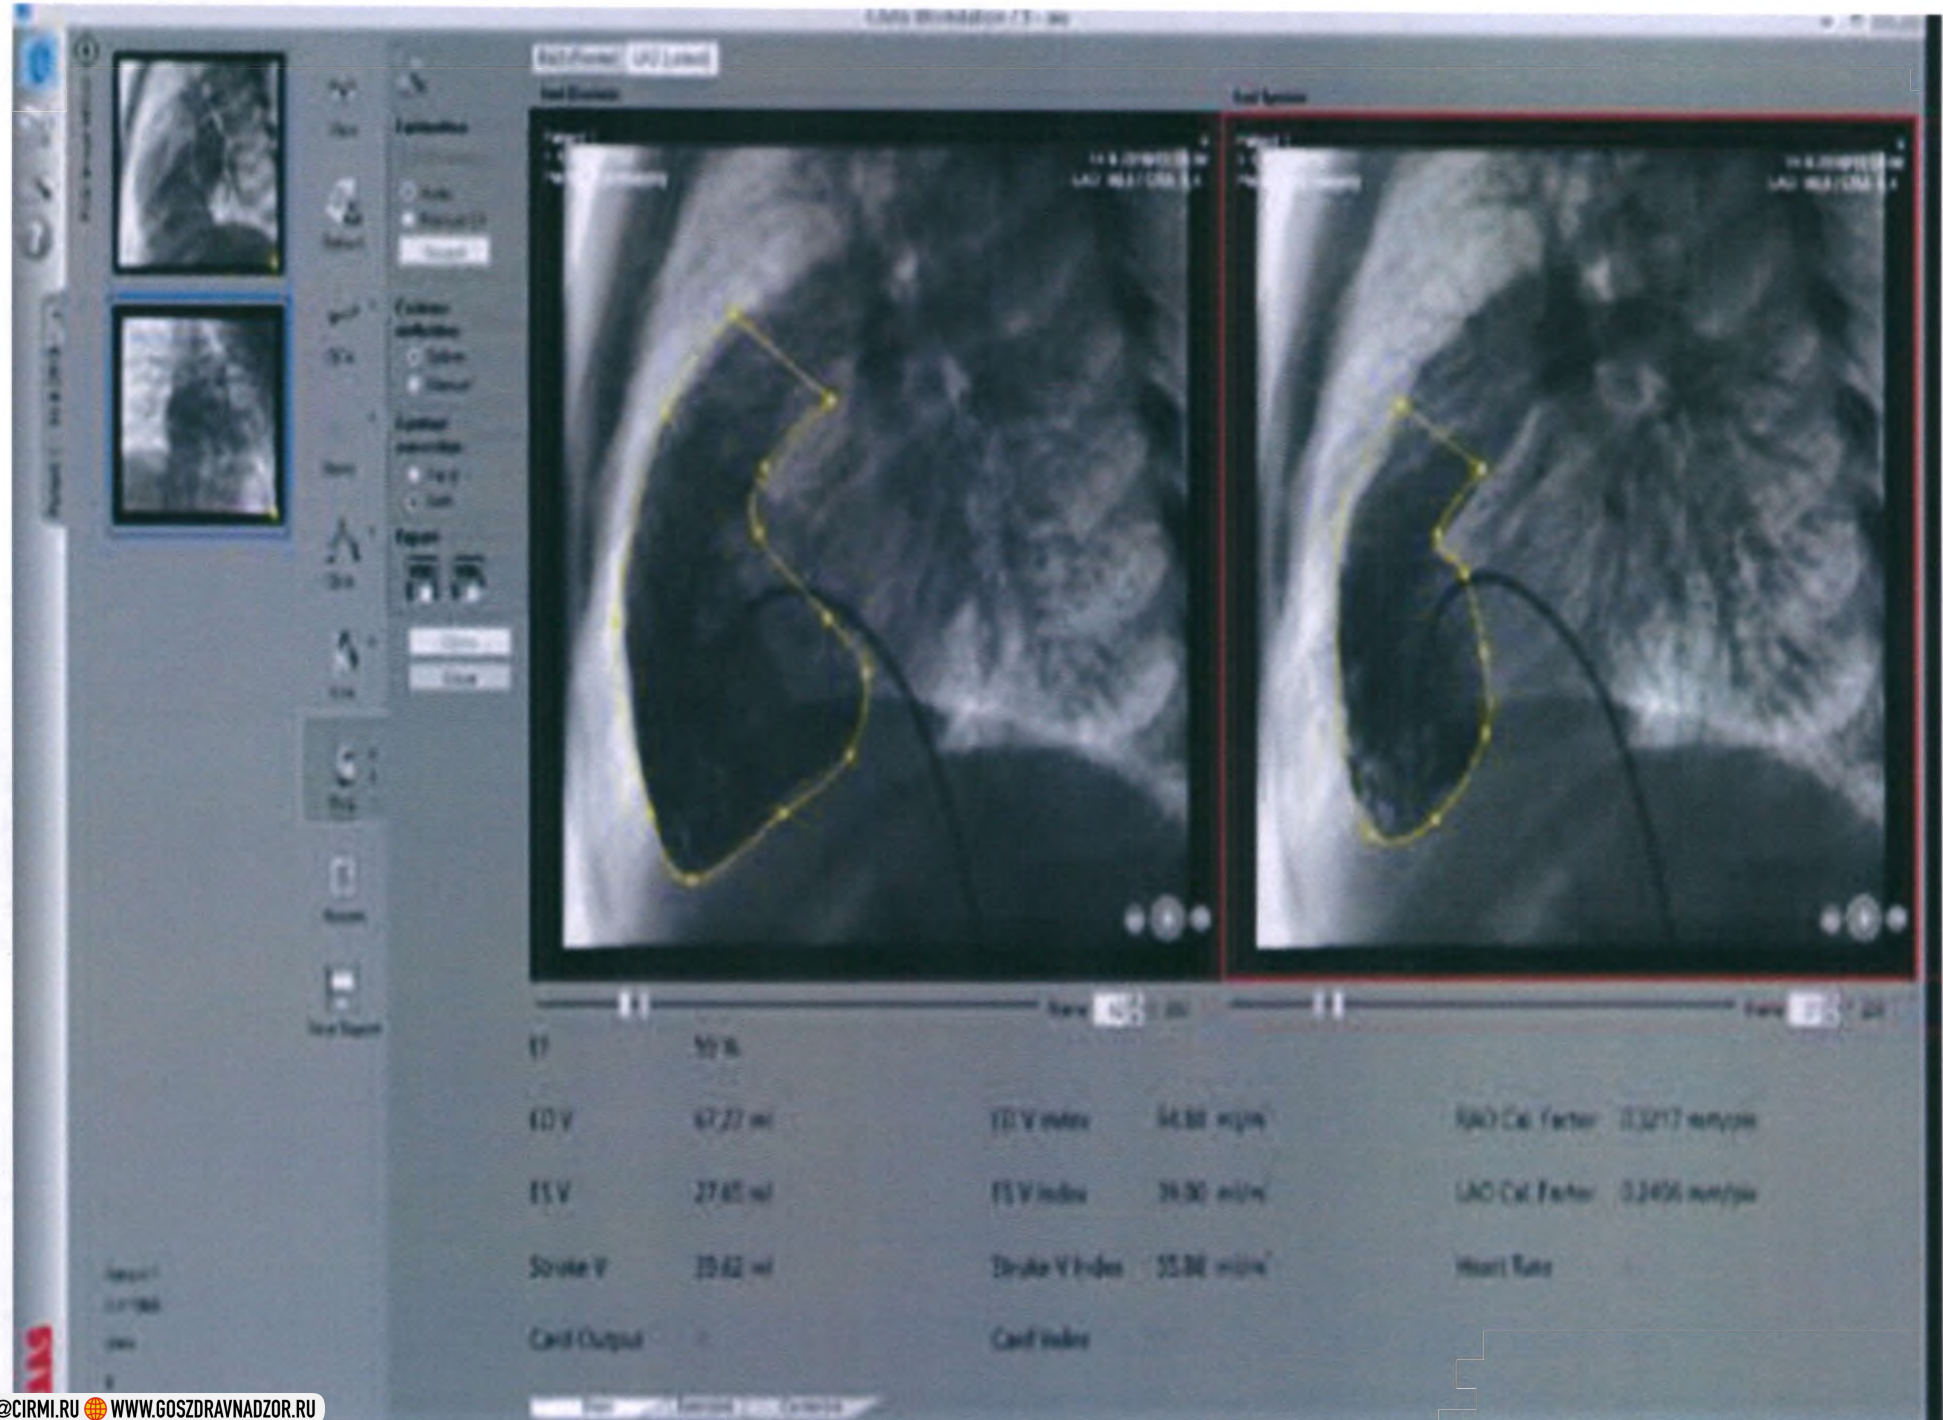


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QCA3D (3D-анализ коронарных артерий)

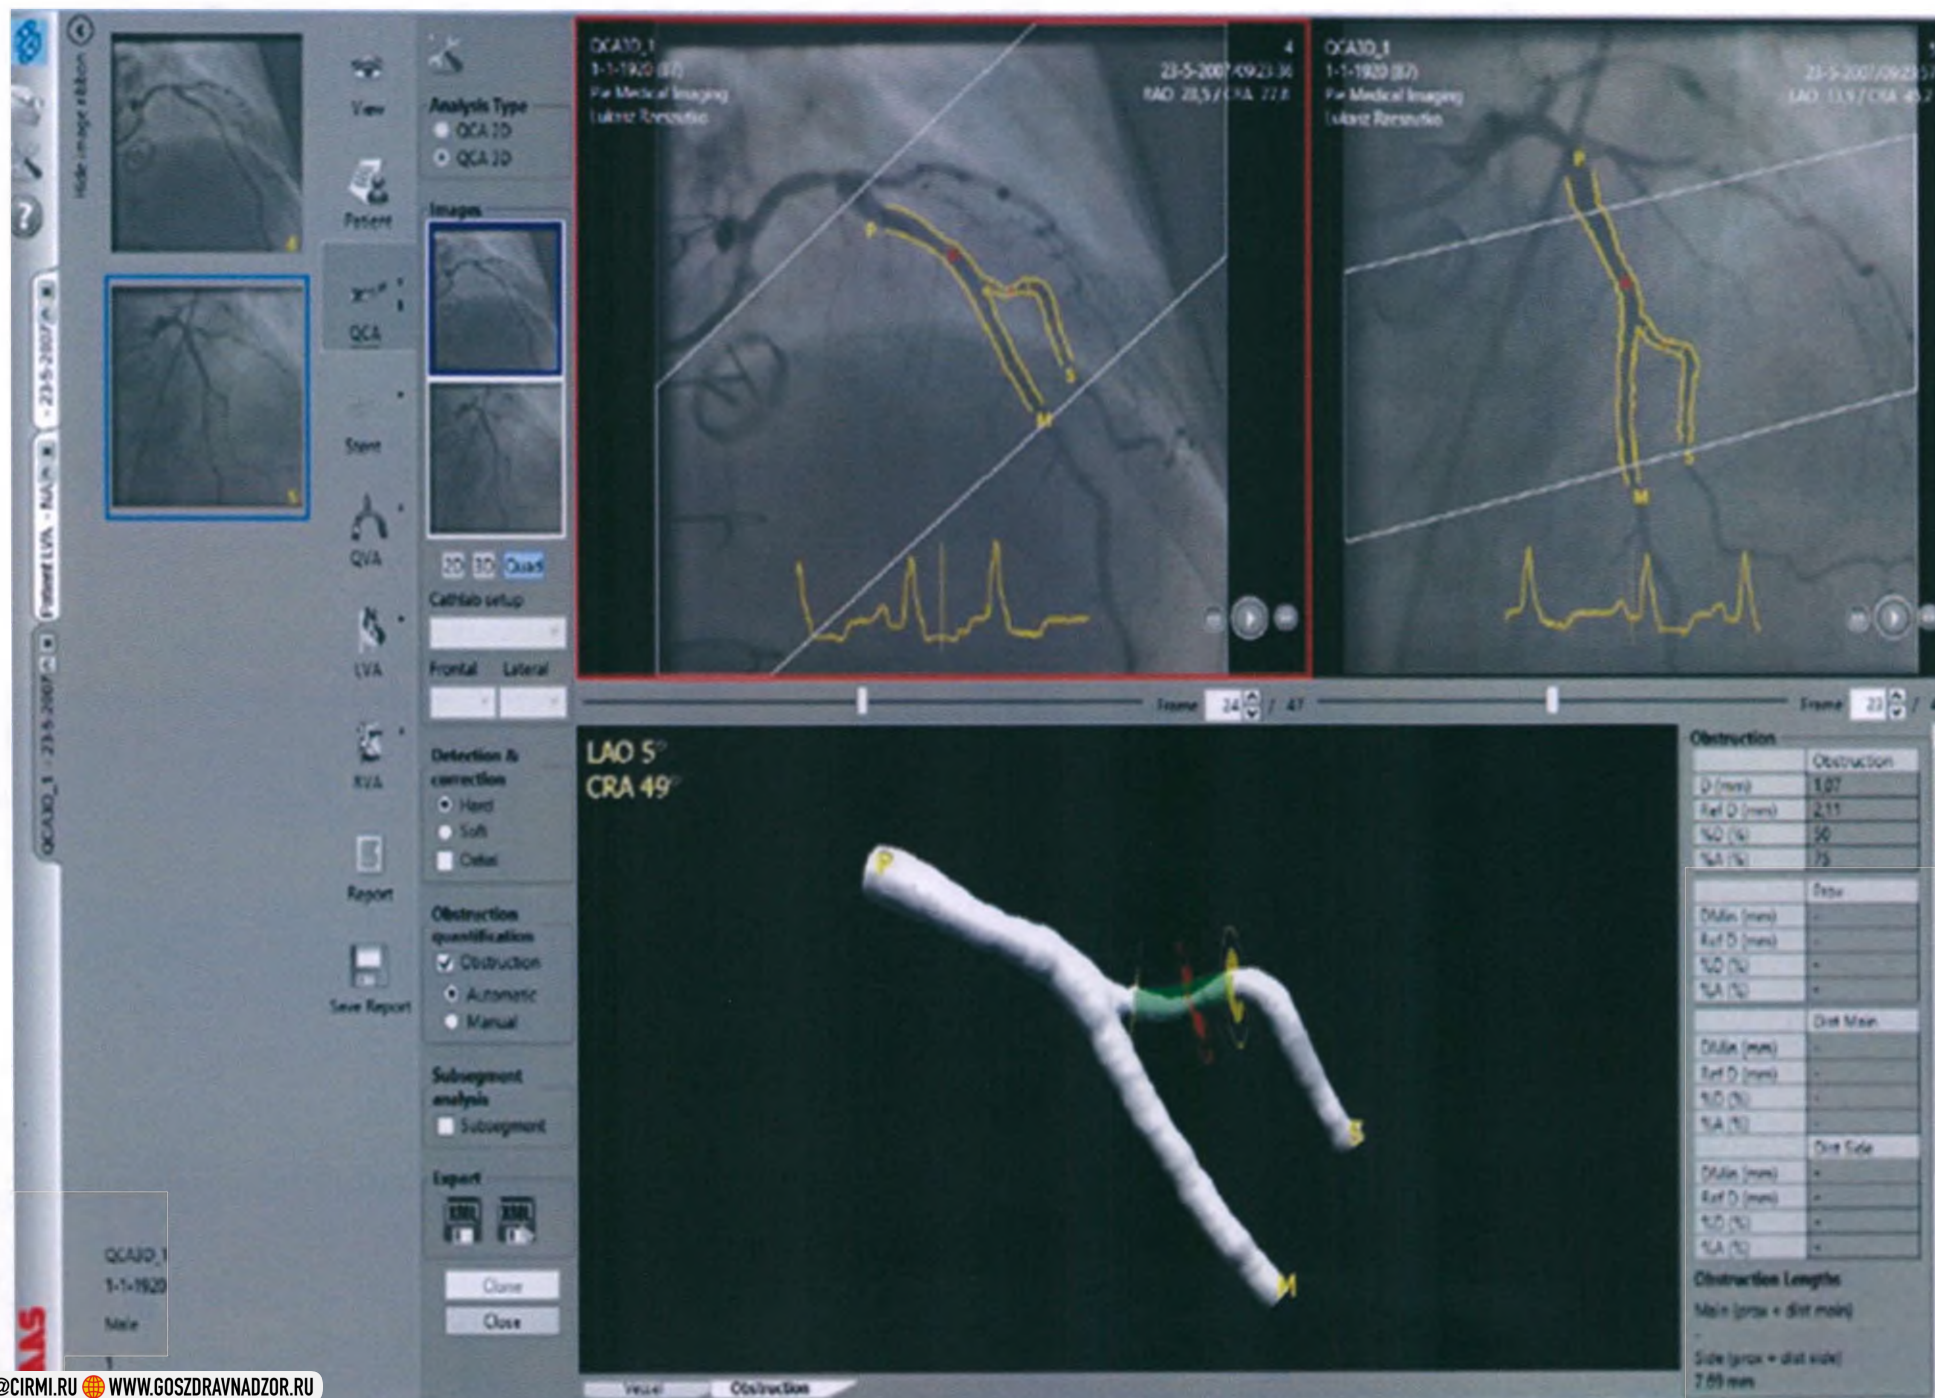


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа Stent Enhancer (отображение с контрастированием стента)

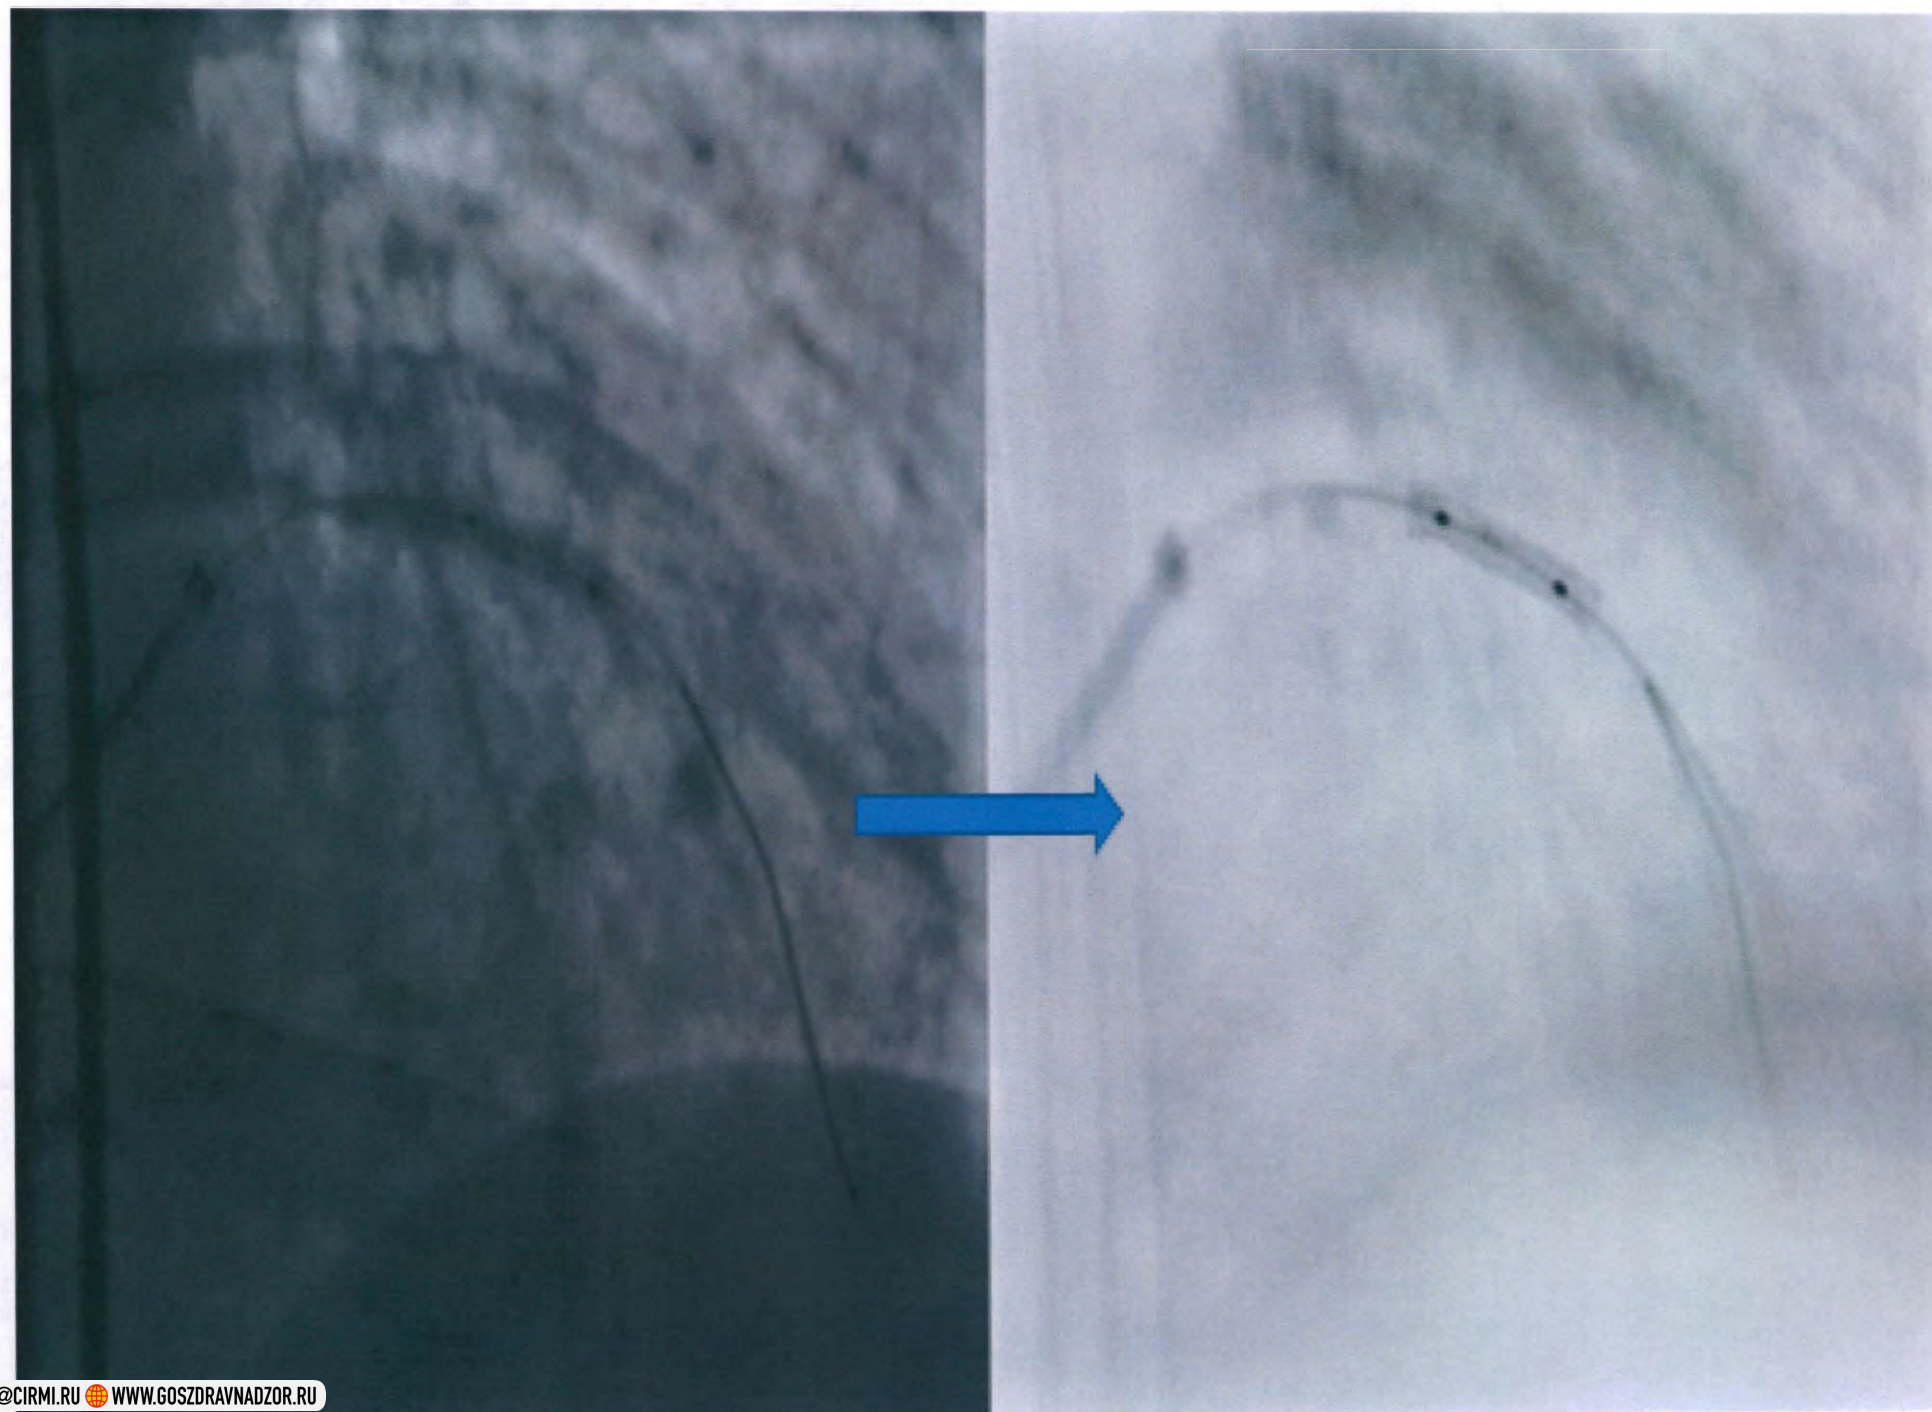


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа IV-LINQ (одновременная регистрация рентгеновских изображений и изображений ВСУЗИ/ОКТ)

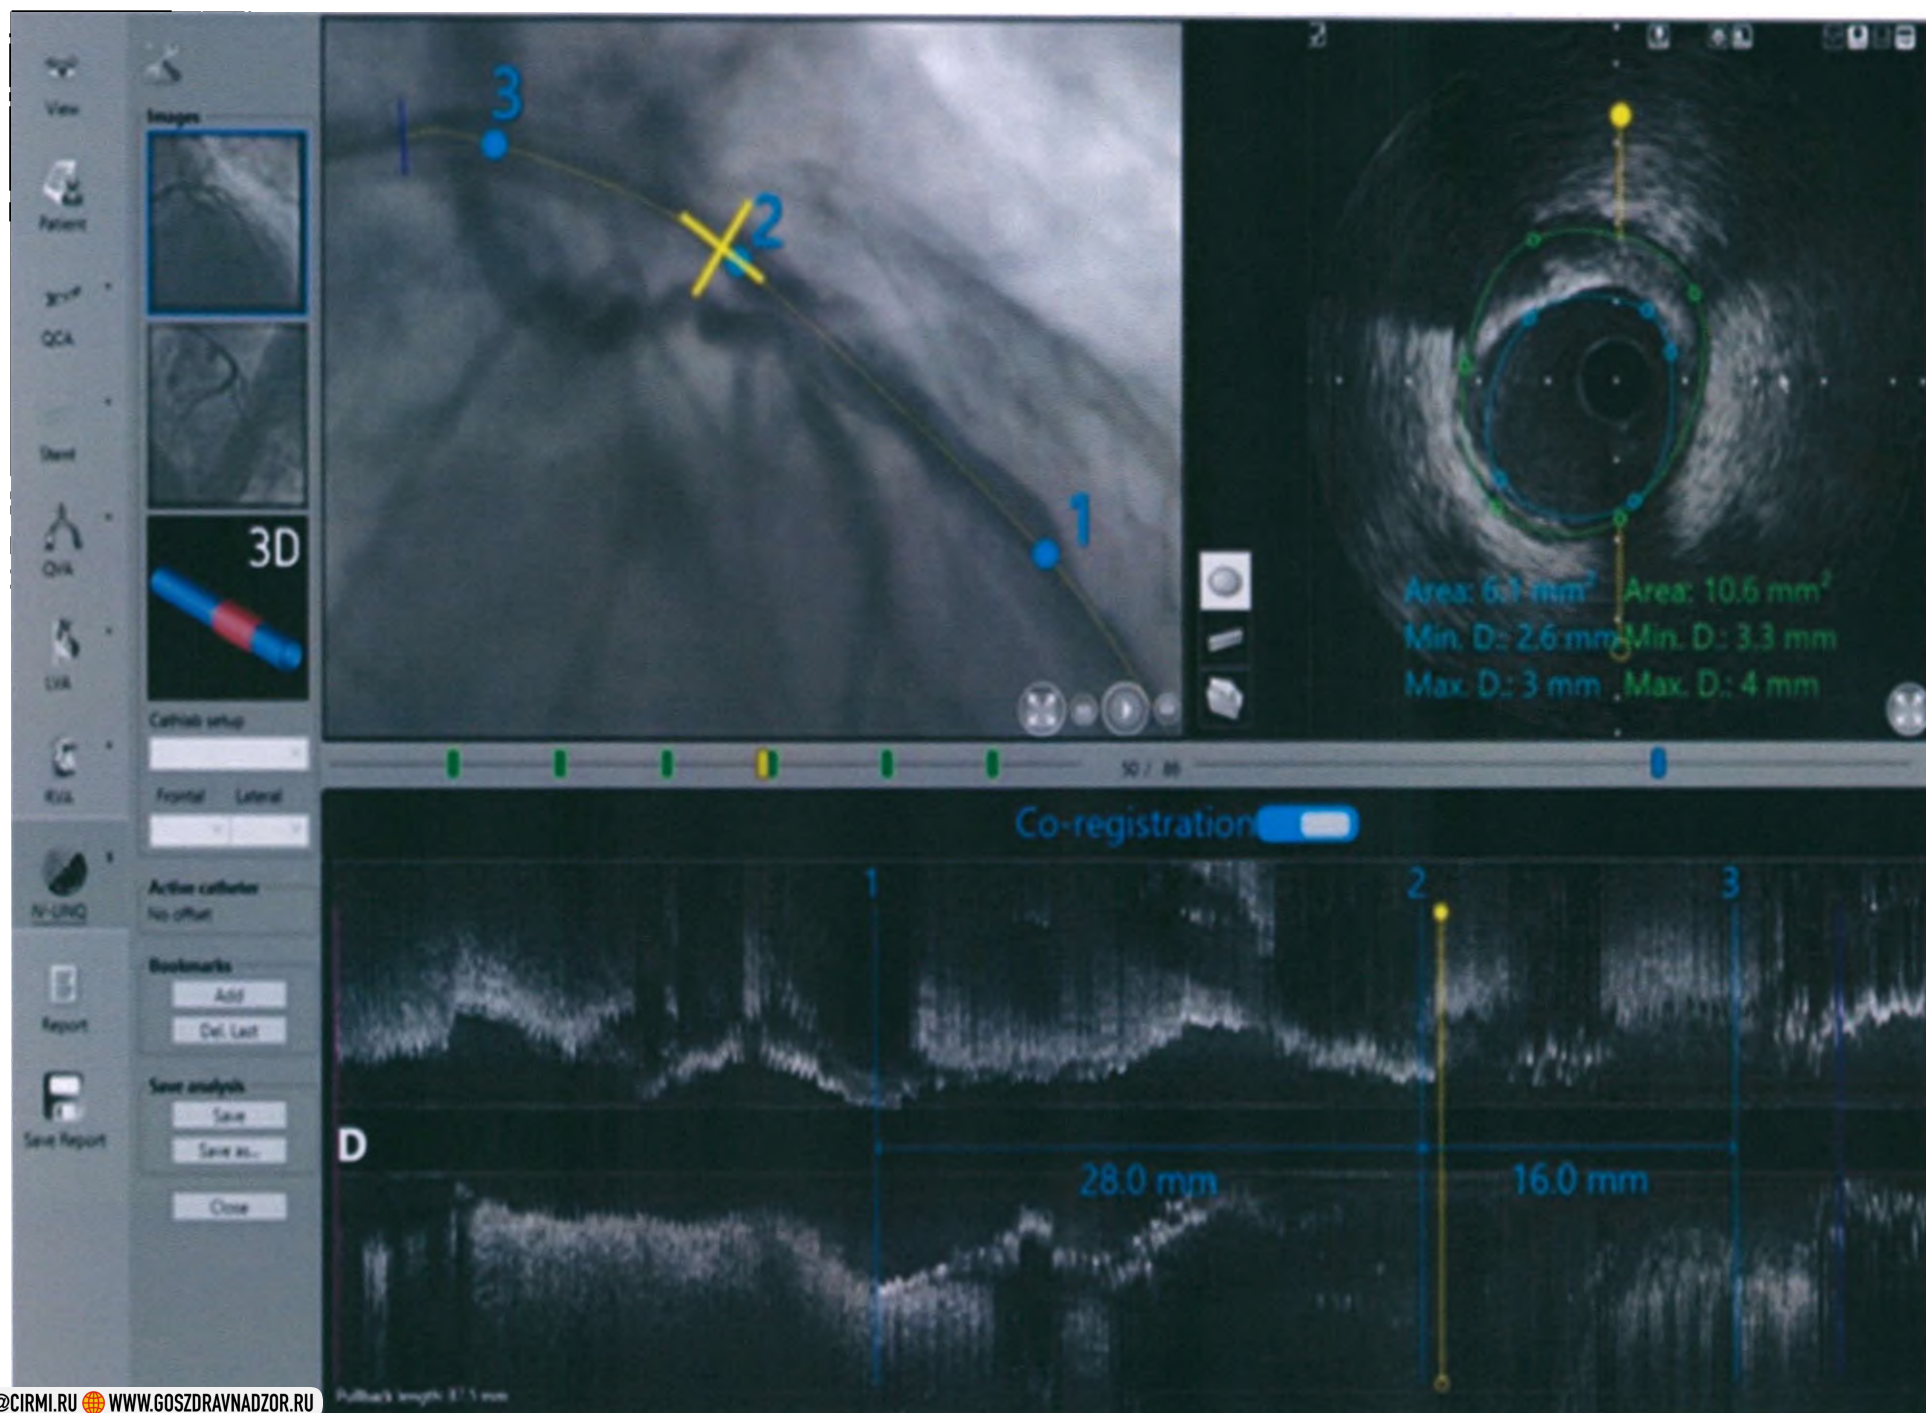


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для 3D-картирования;

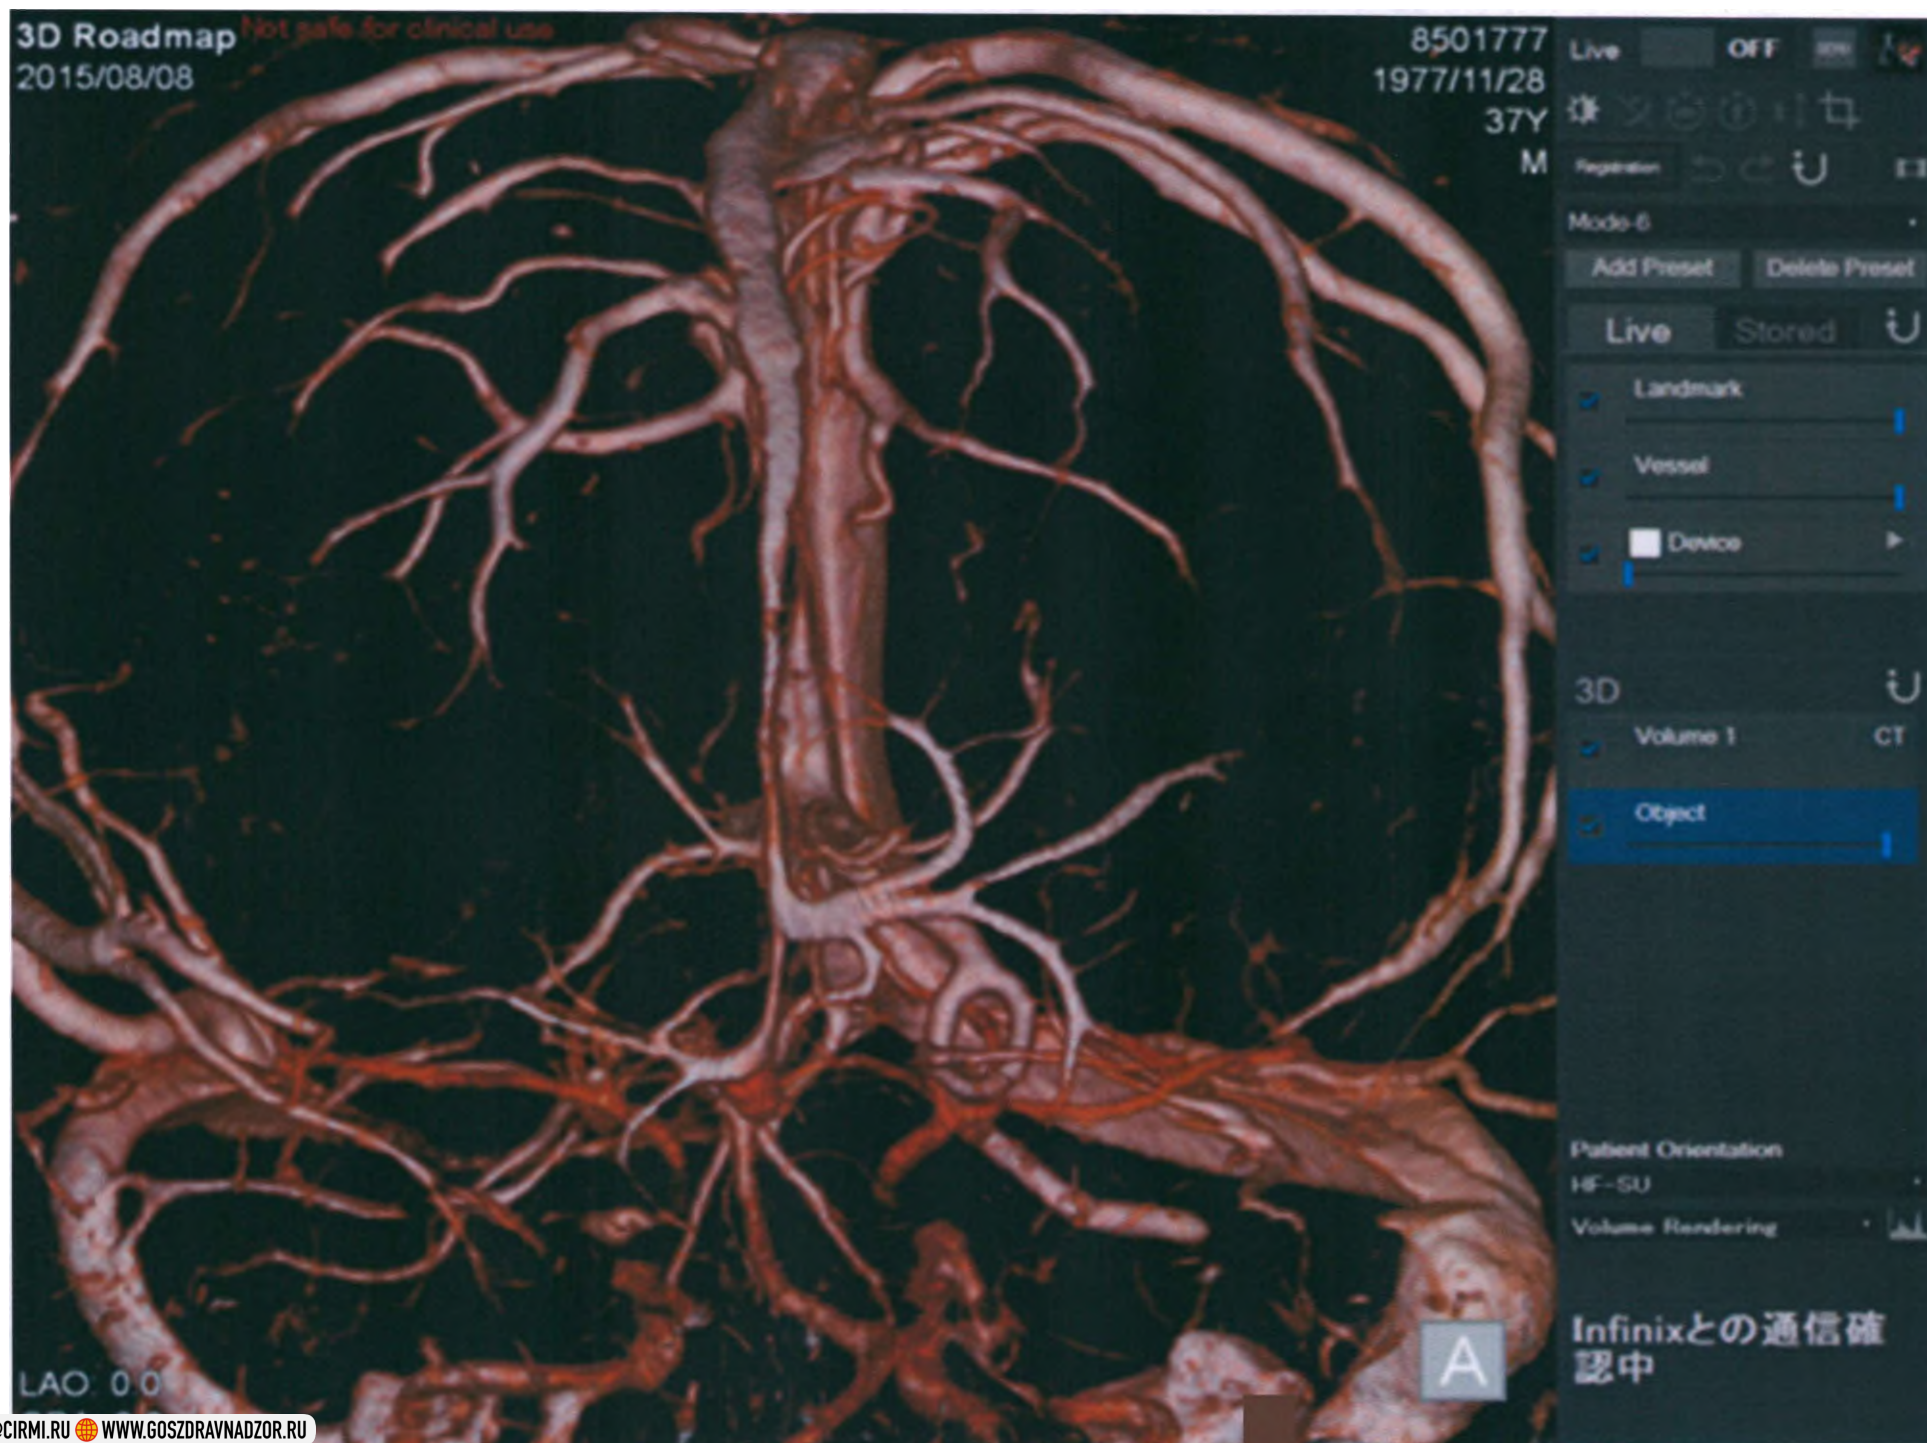

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для мультимодального картирования

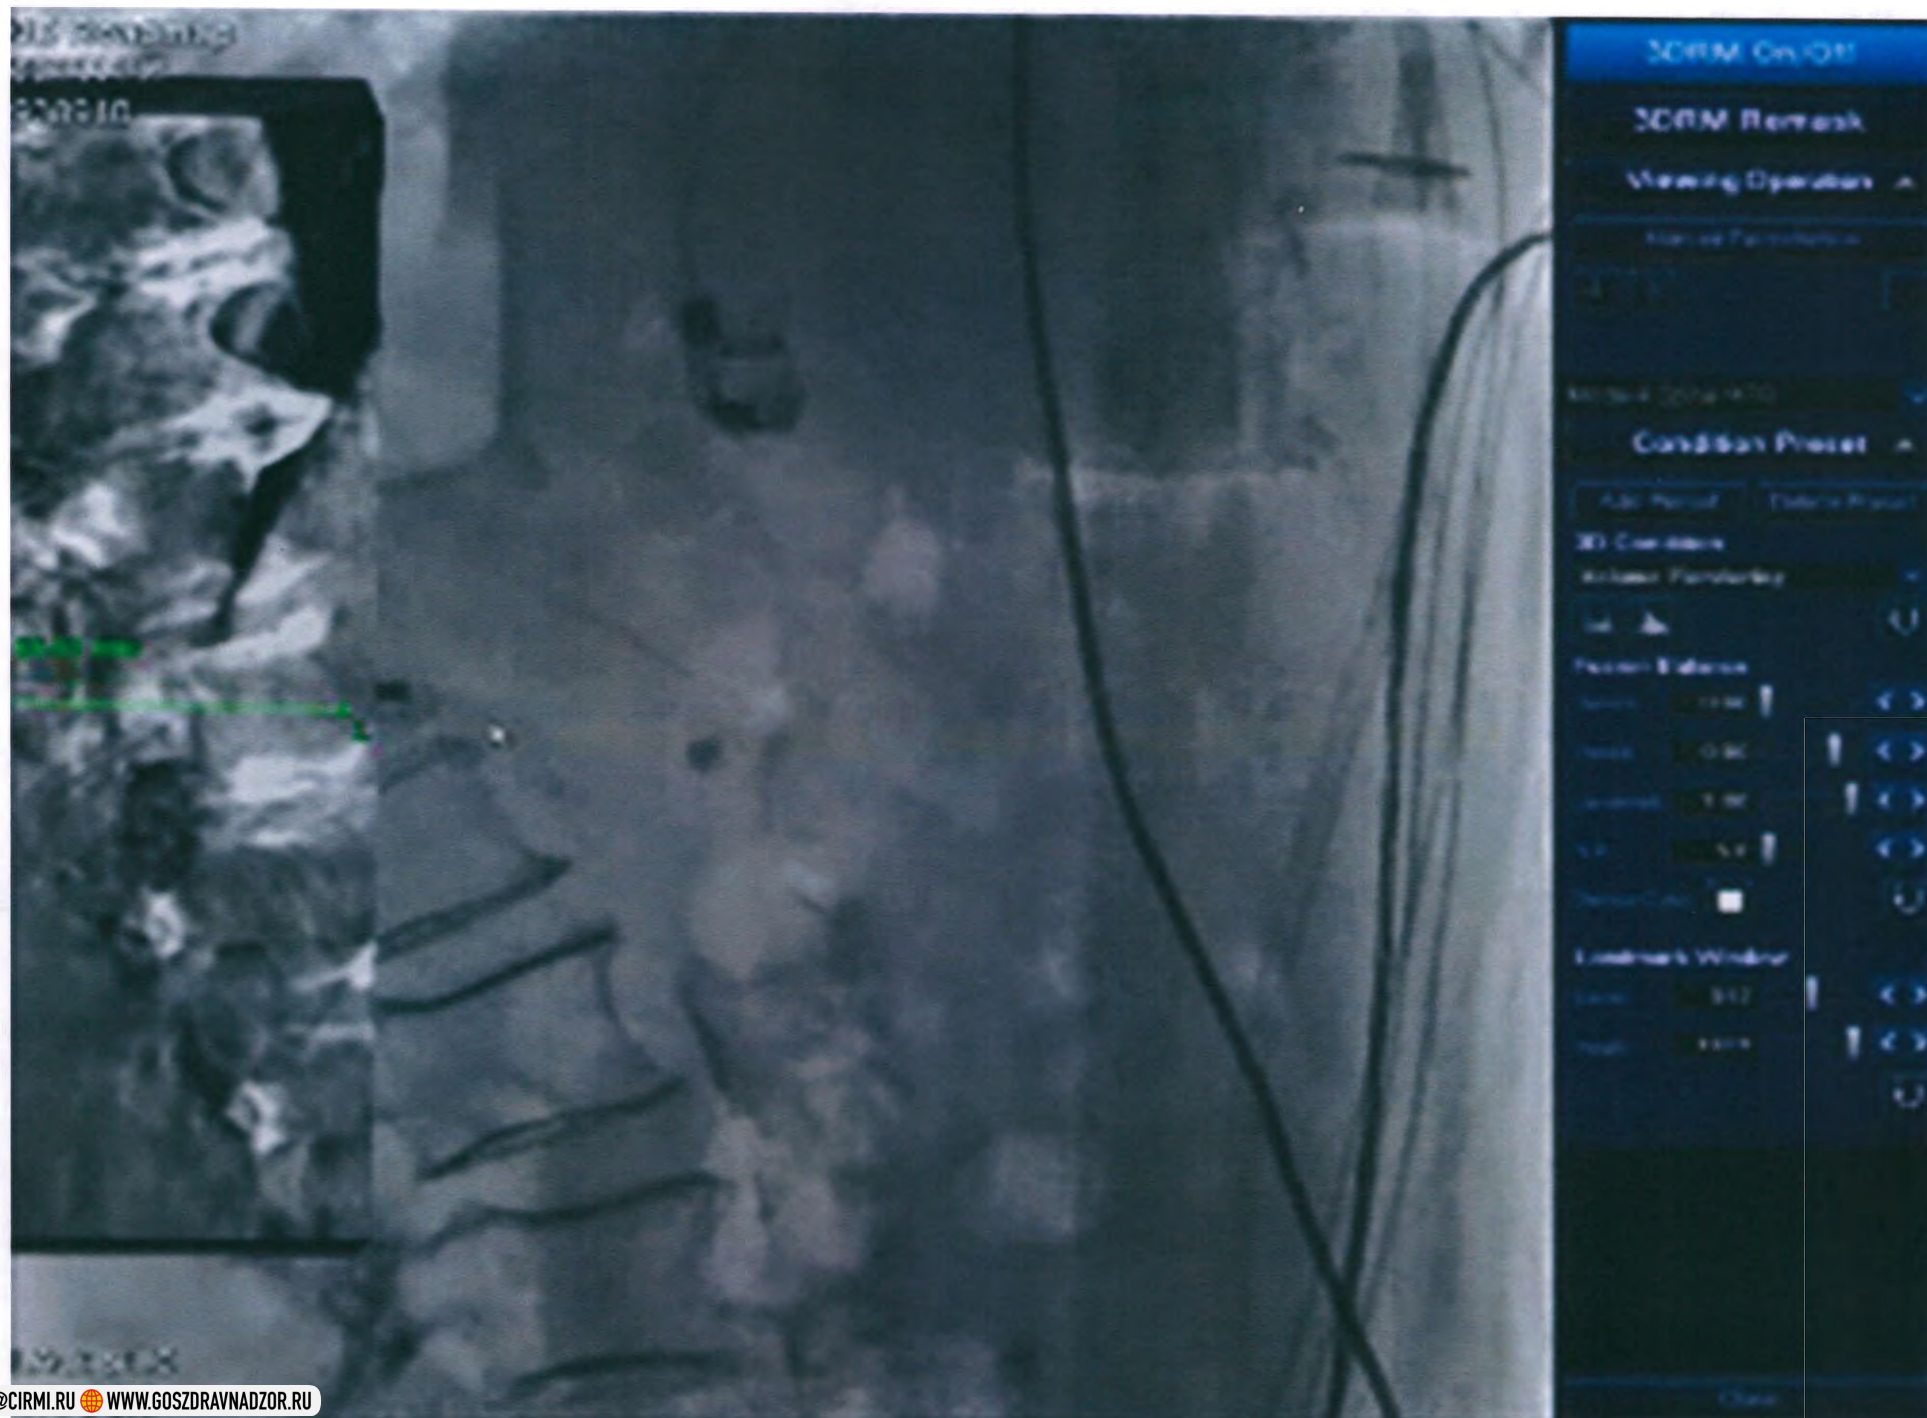


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для поддержки TAVR (3mensio)

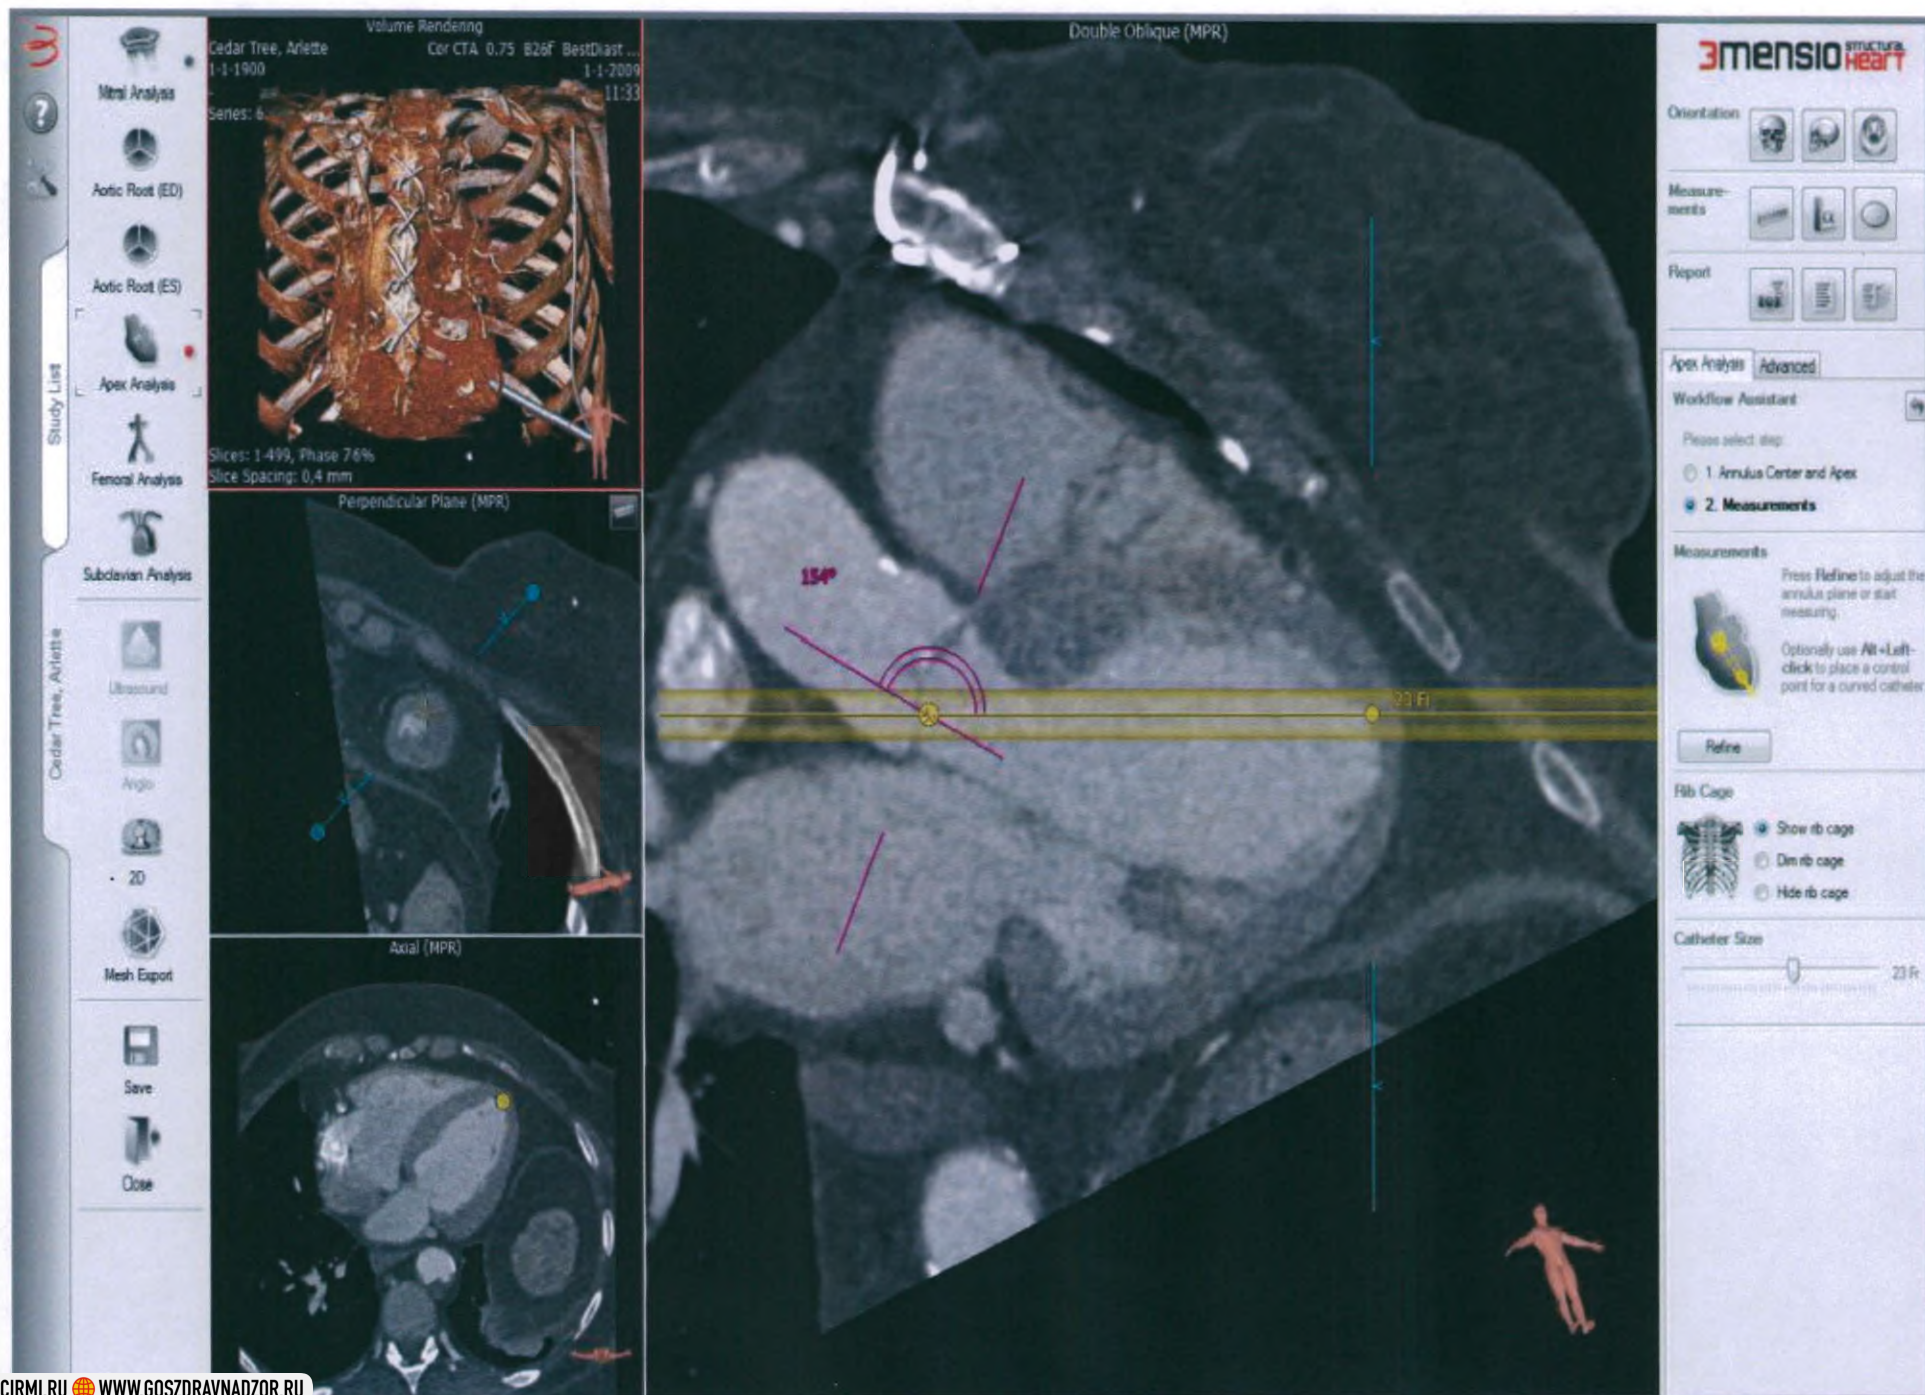





89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа митрального клапана;

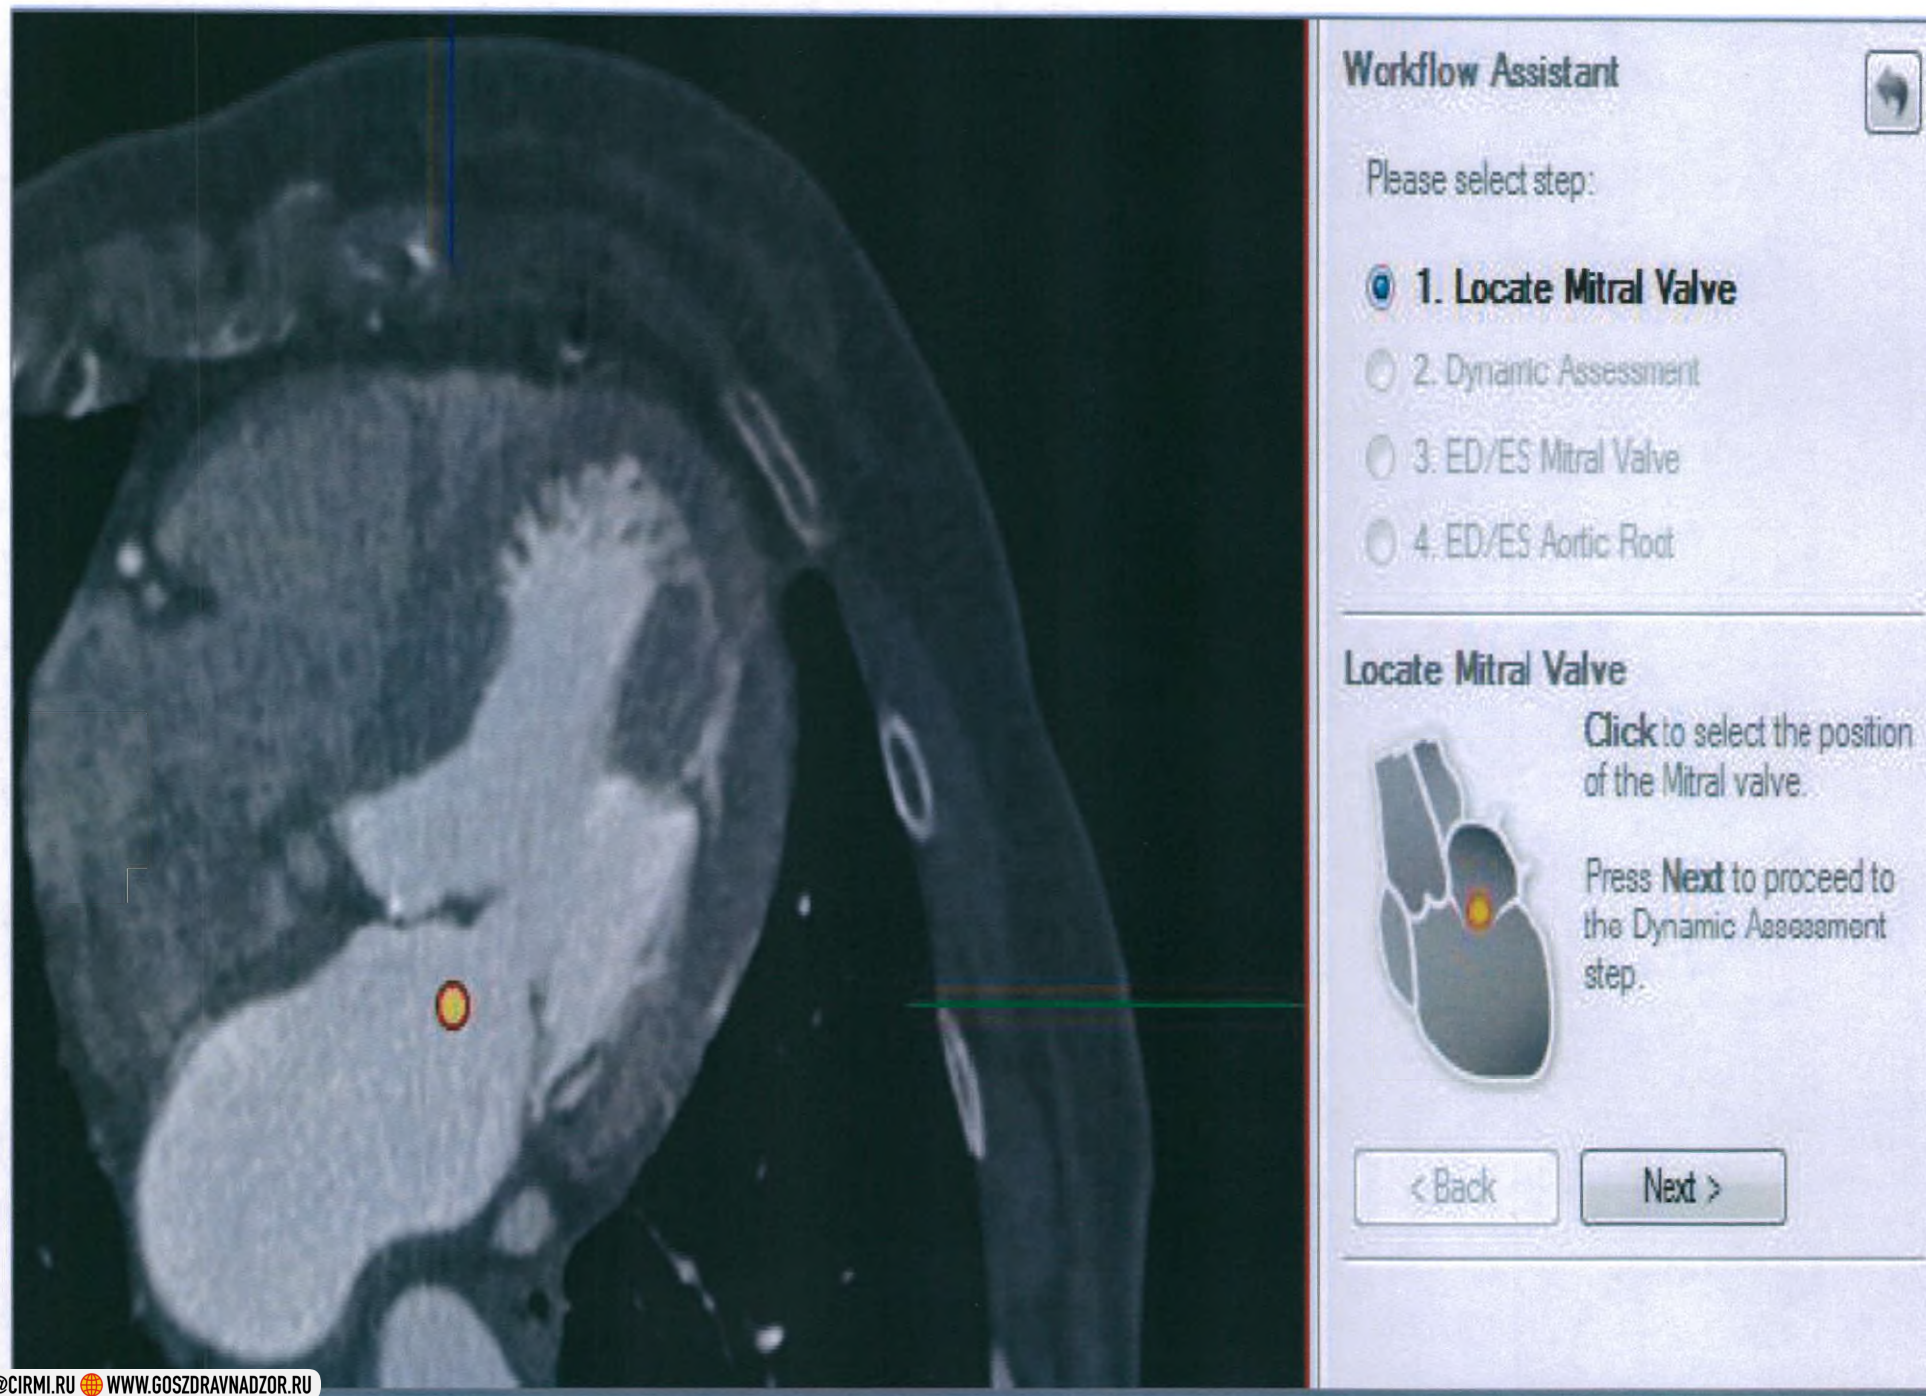


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа ушка левого предсердия

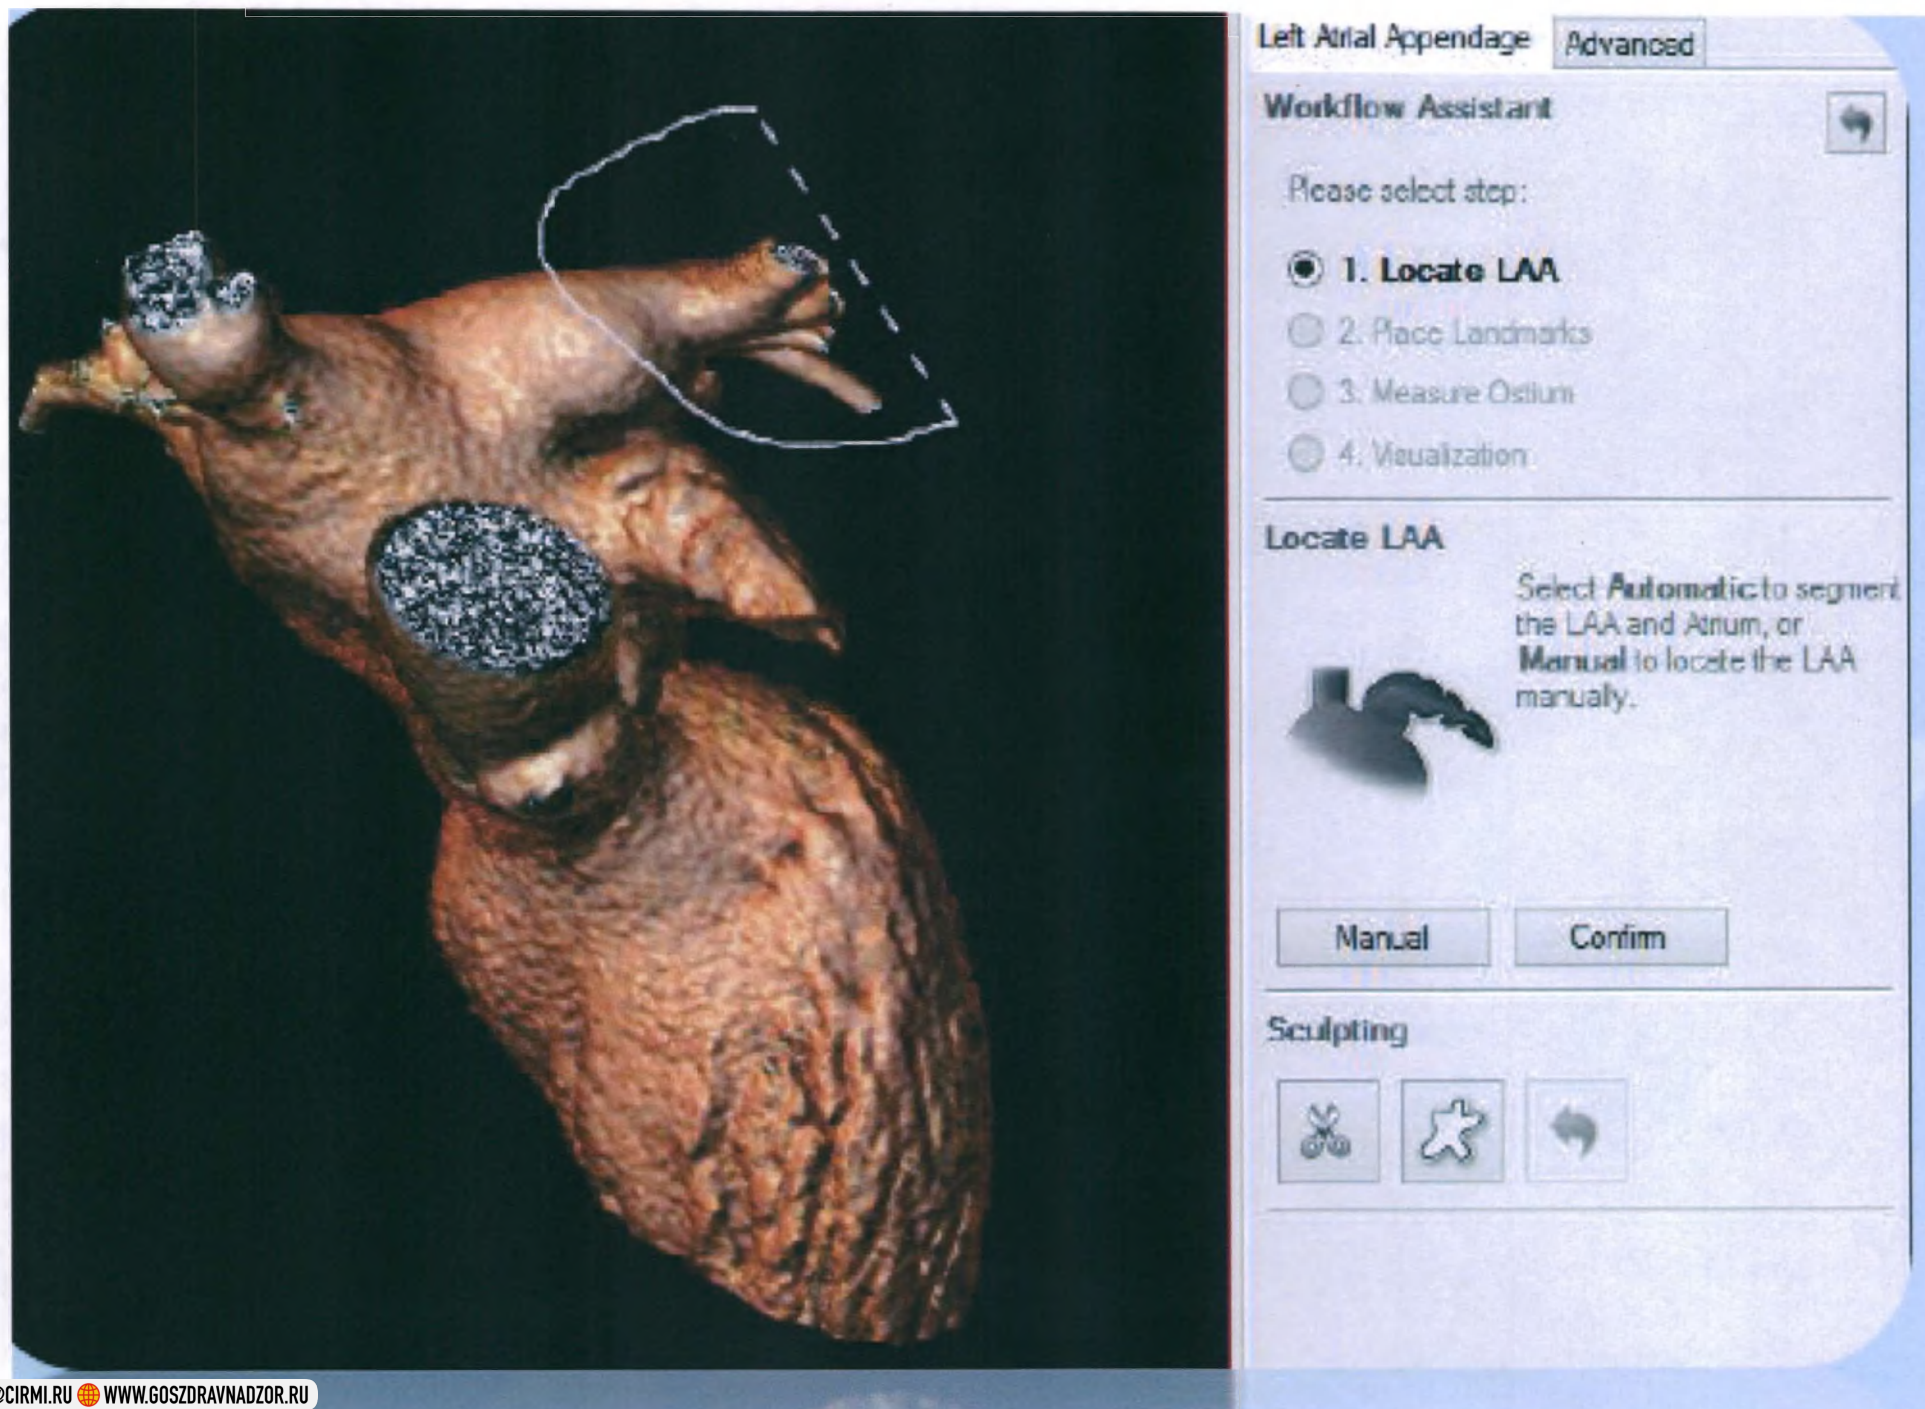

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа регургитации

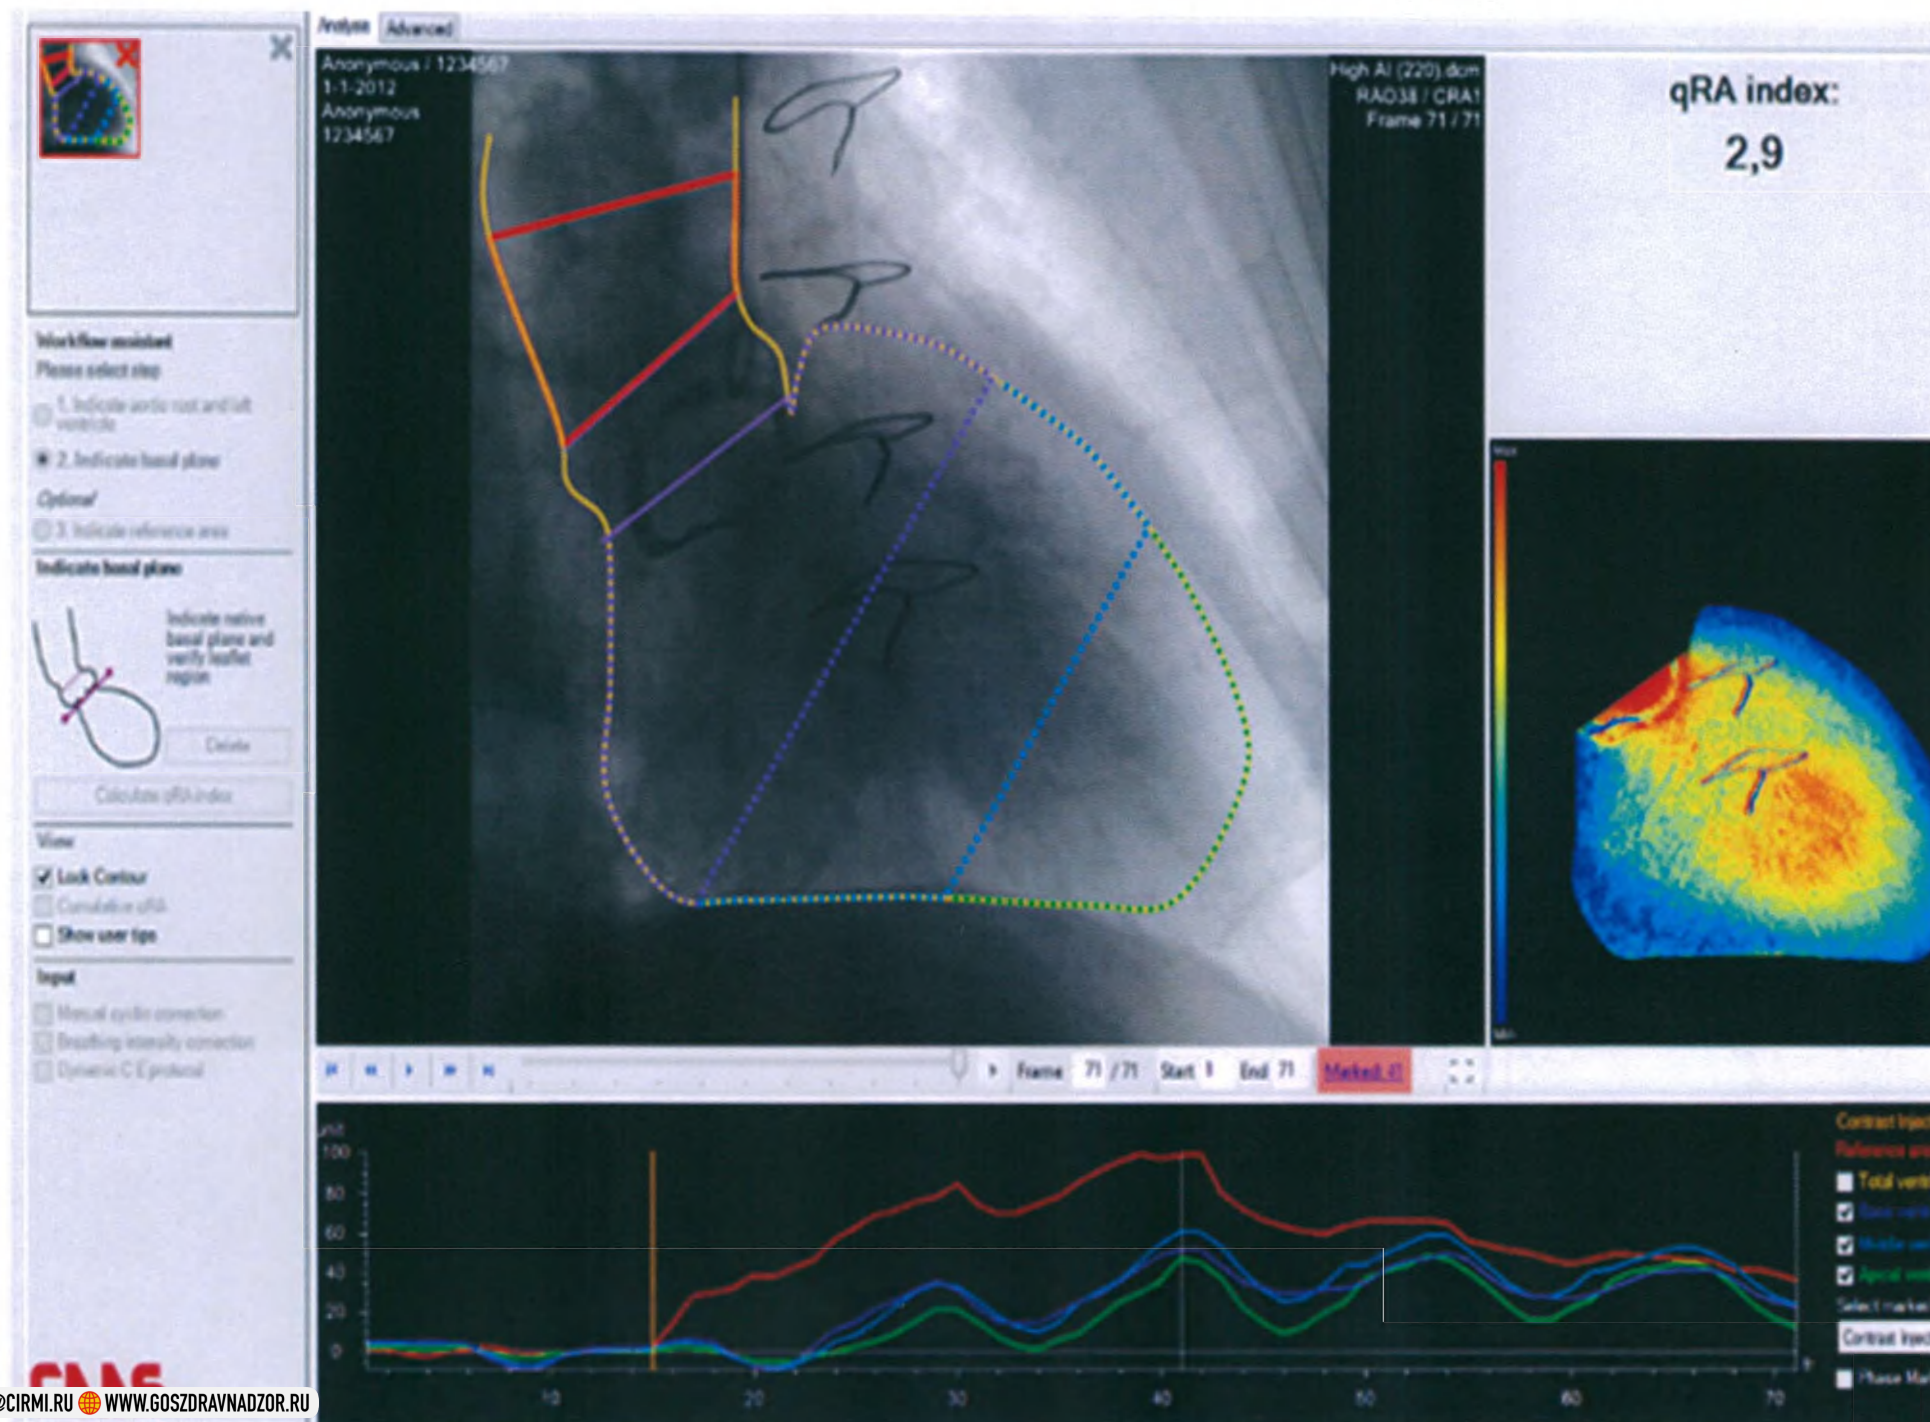


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет DTS для отслеживания дозы

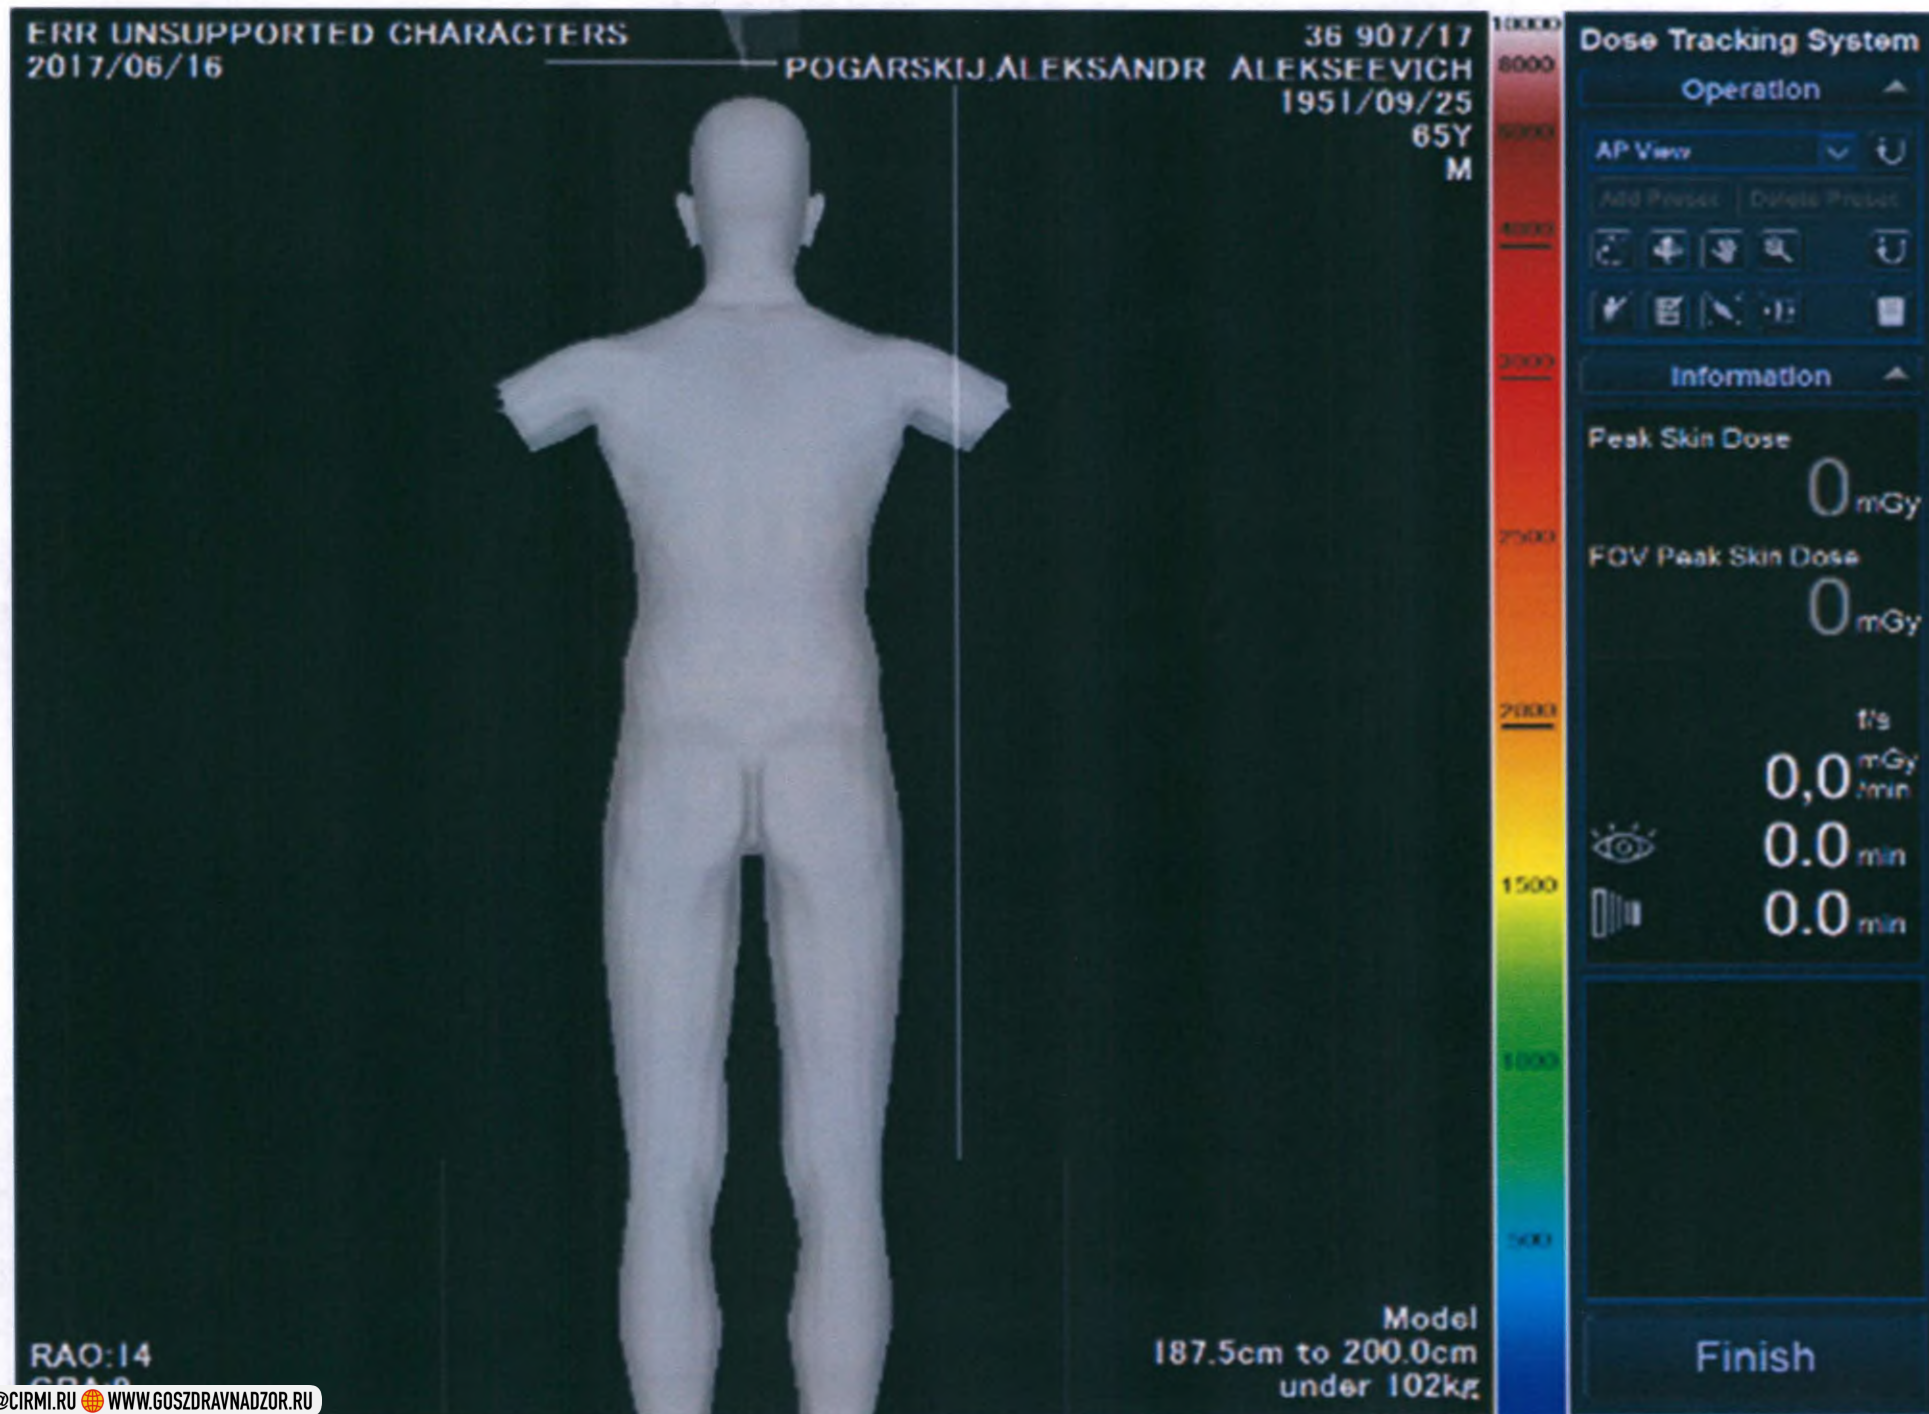

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет динамической стабилизации устройства



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа аневризмы сосудов головного мозга;

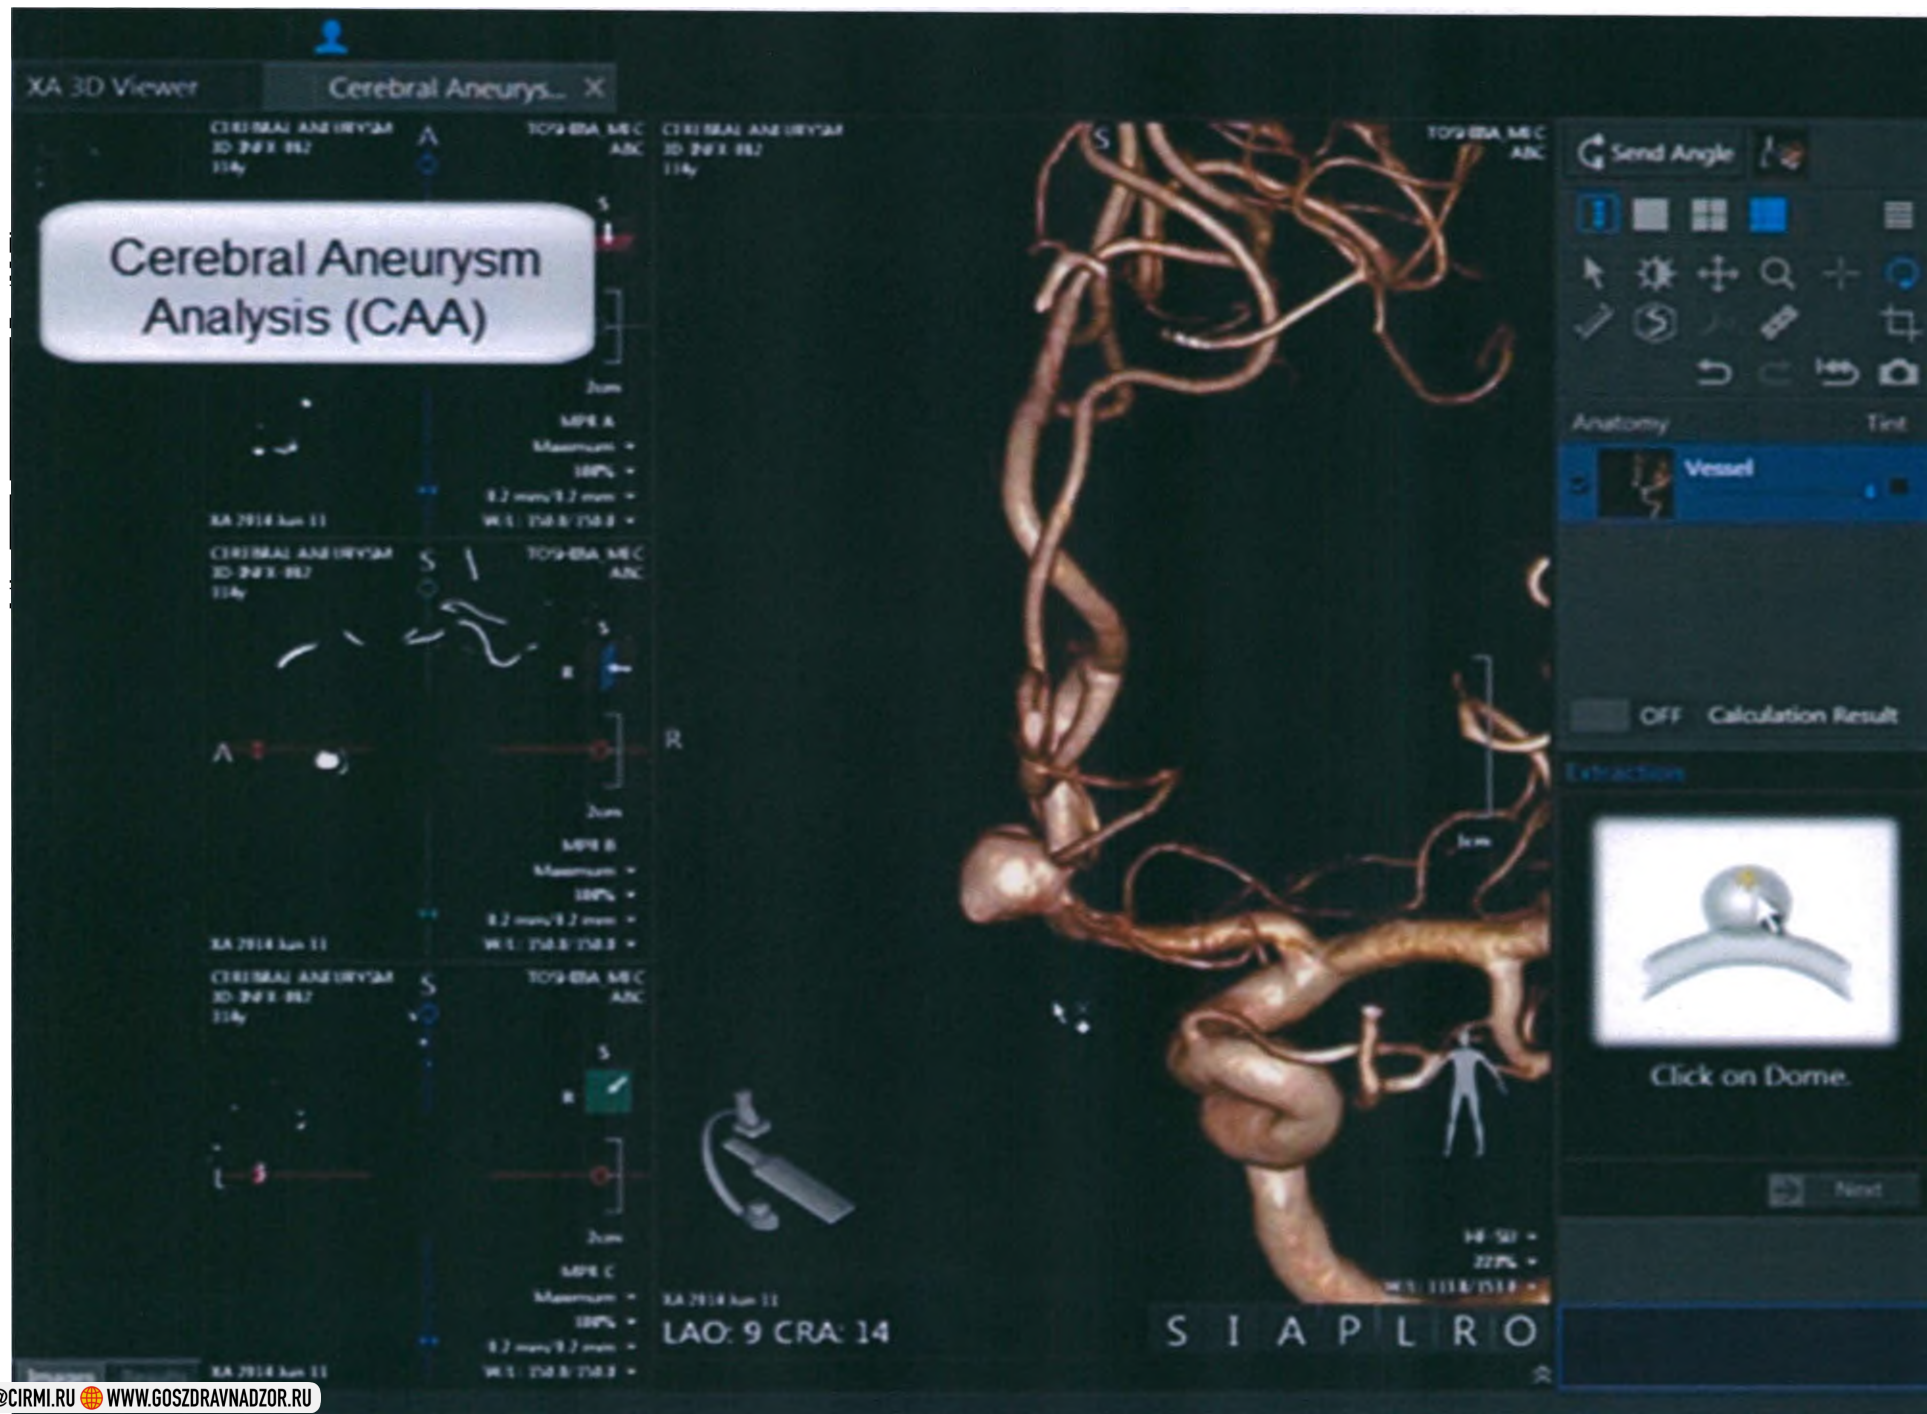



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для планирования эмболизации



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет инструментов 3D-просмотра.




90. Комплект для подключения Rocket Link.

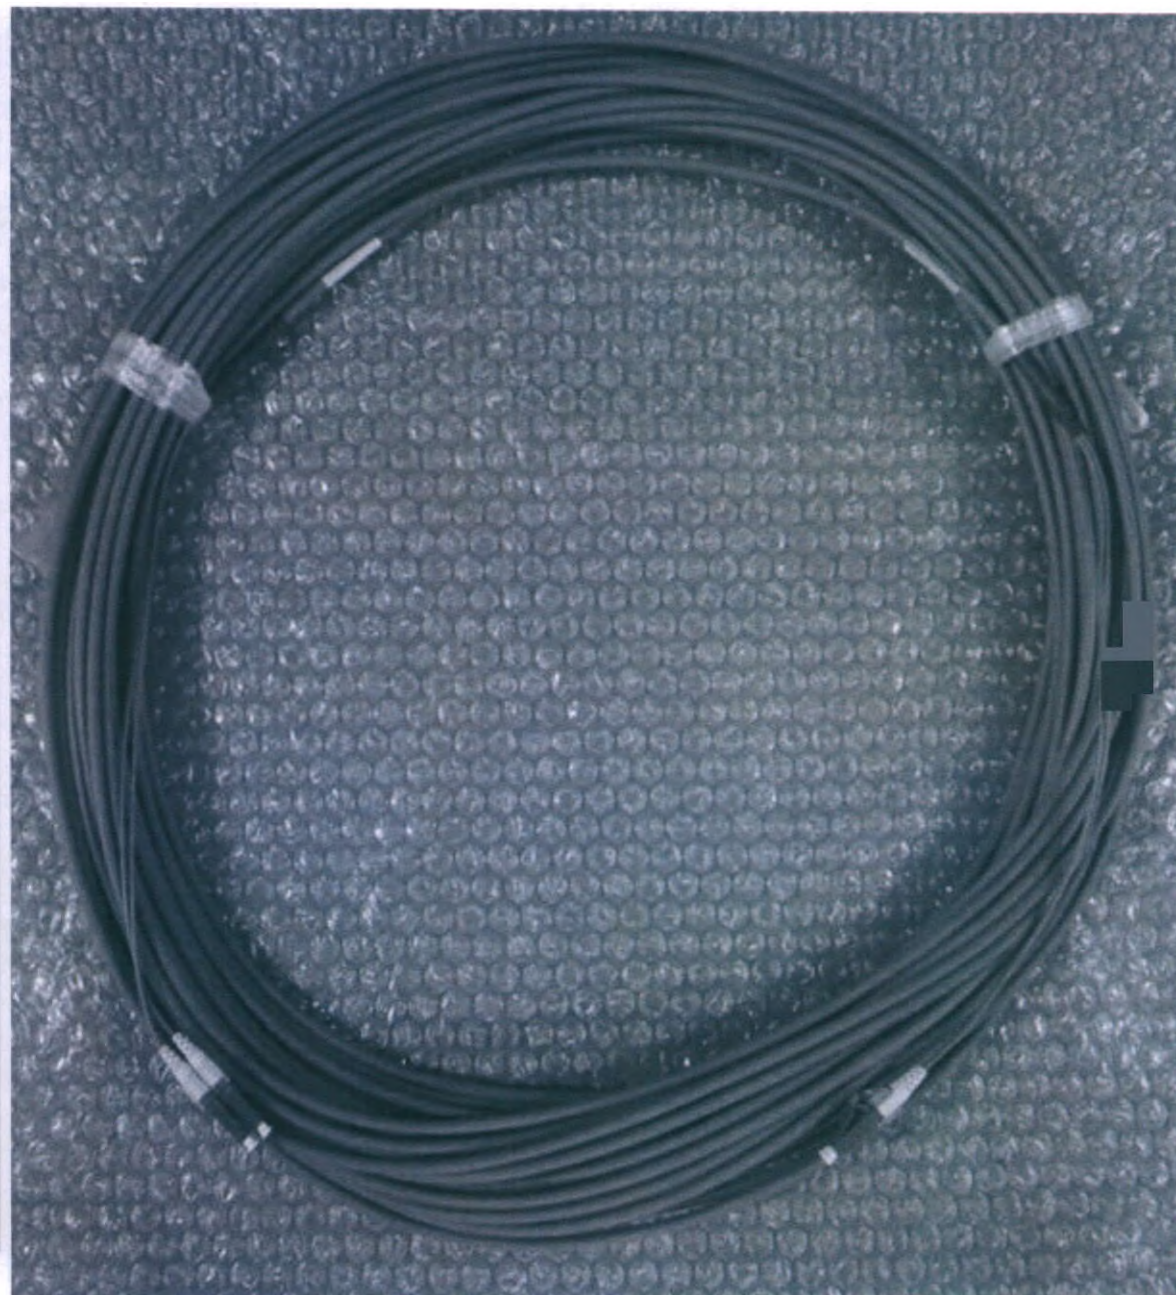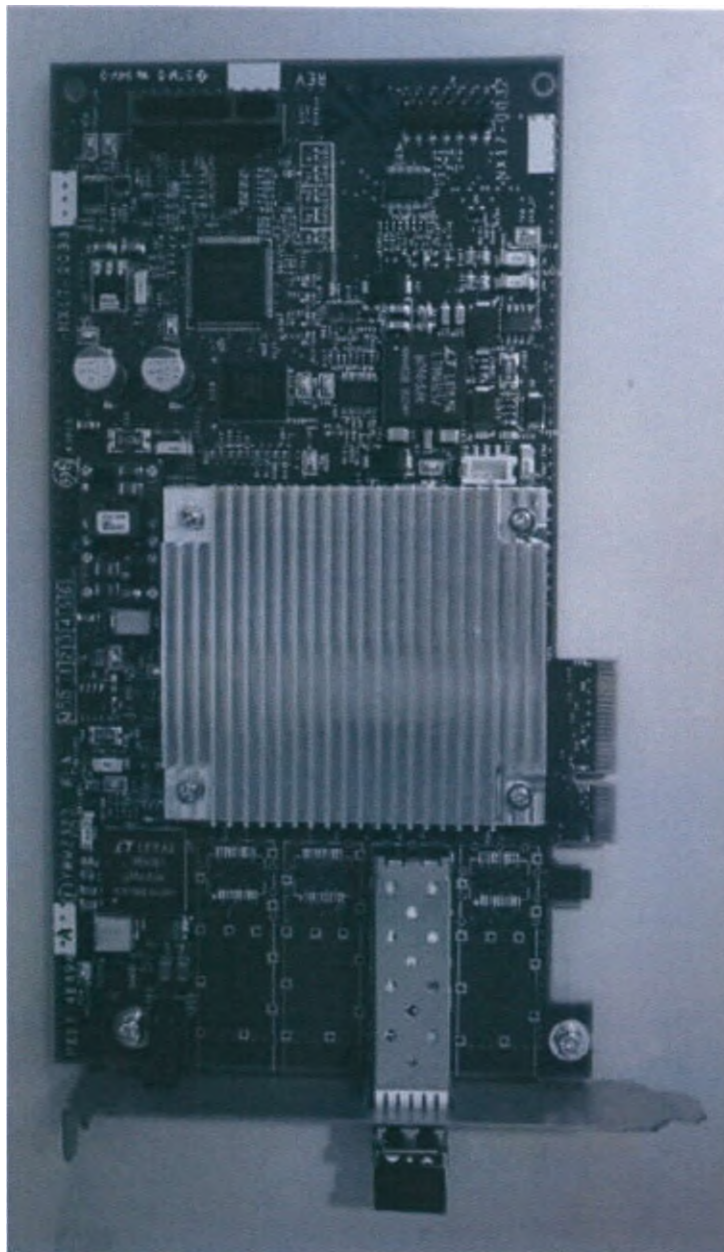






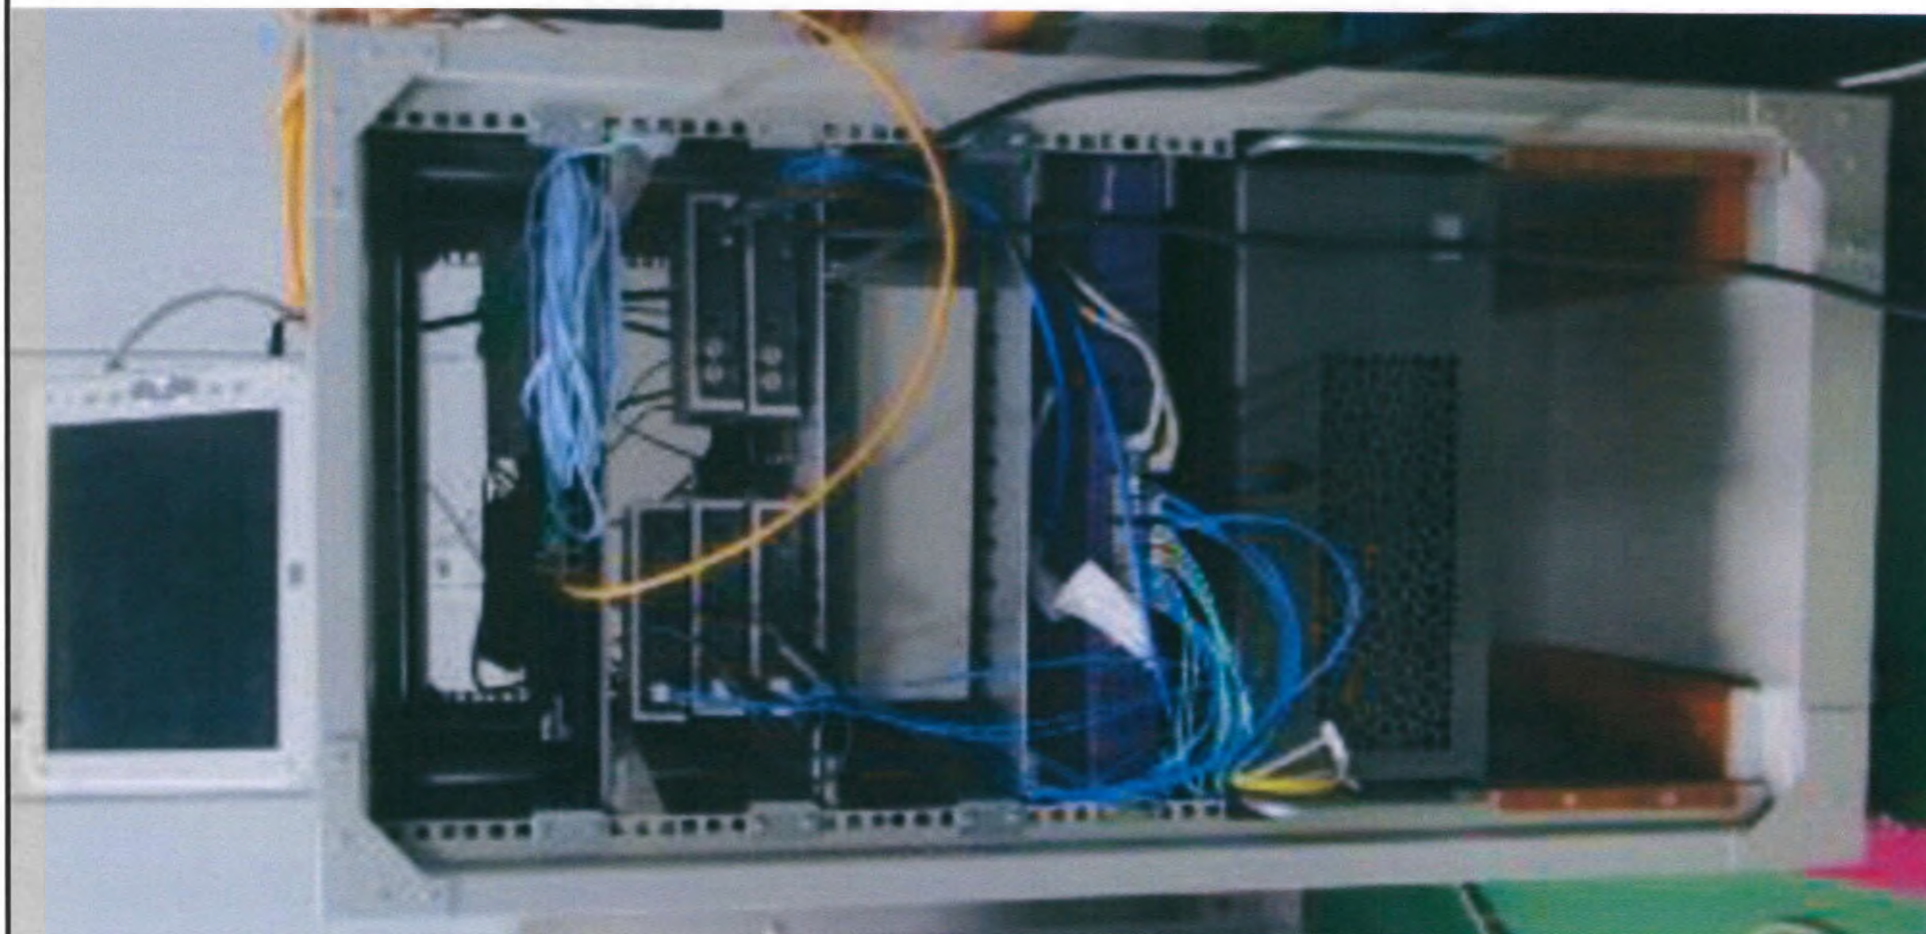



94. Модуль для подключения ИБП.

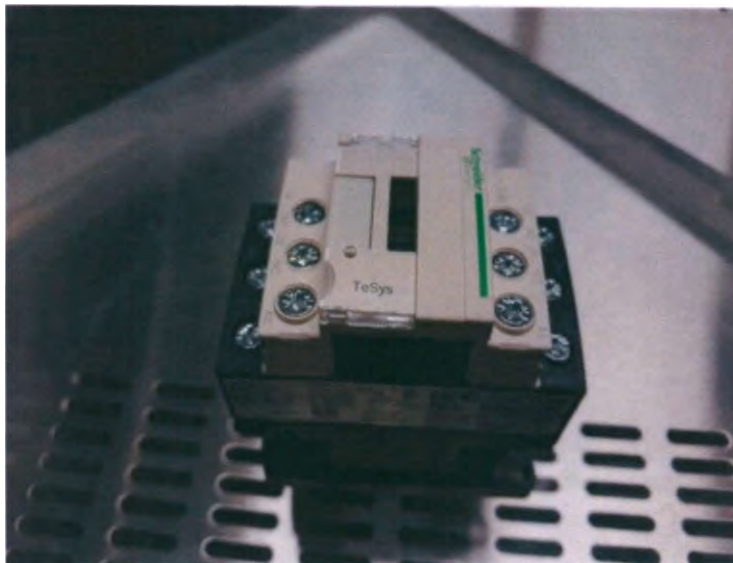

Контактор




Пневматический таймер

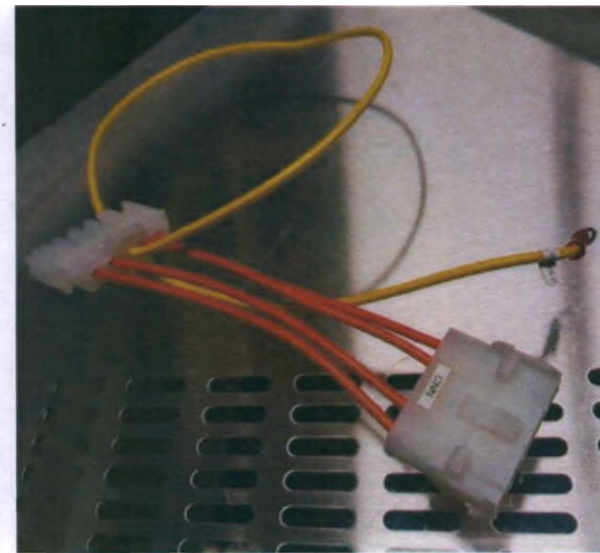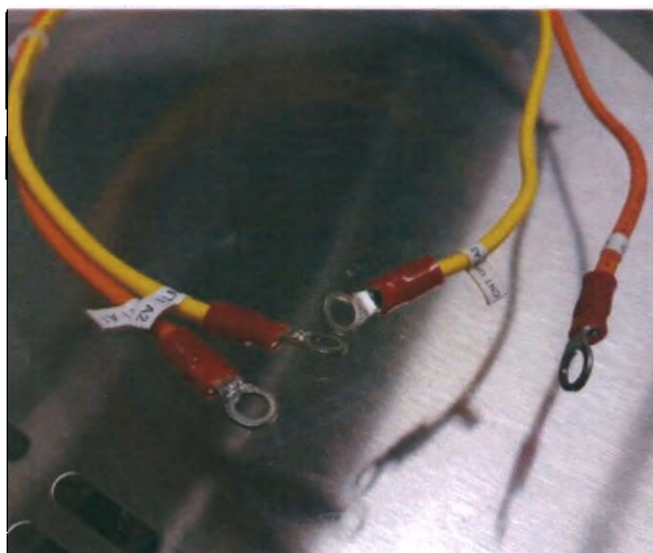

Соединительные кабели





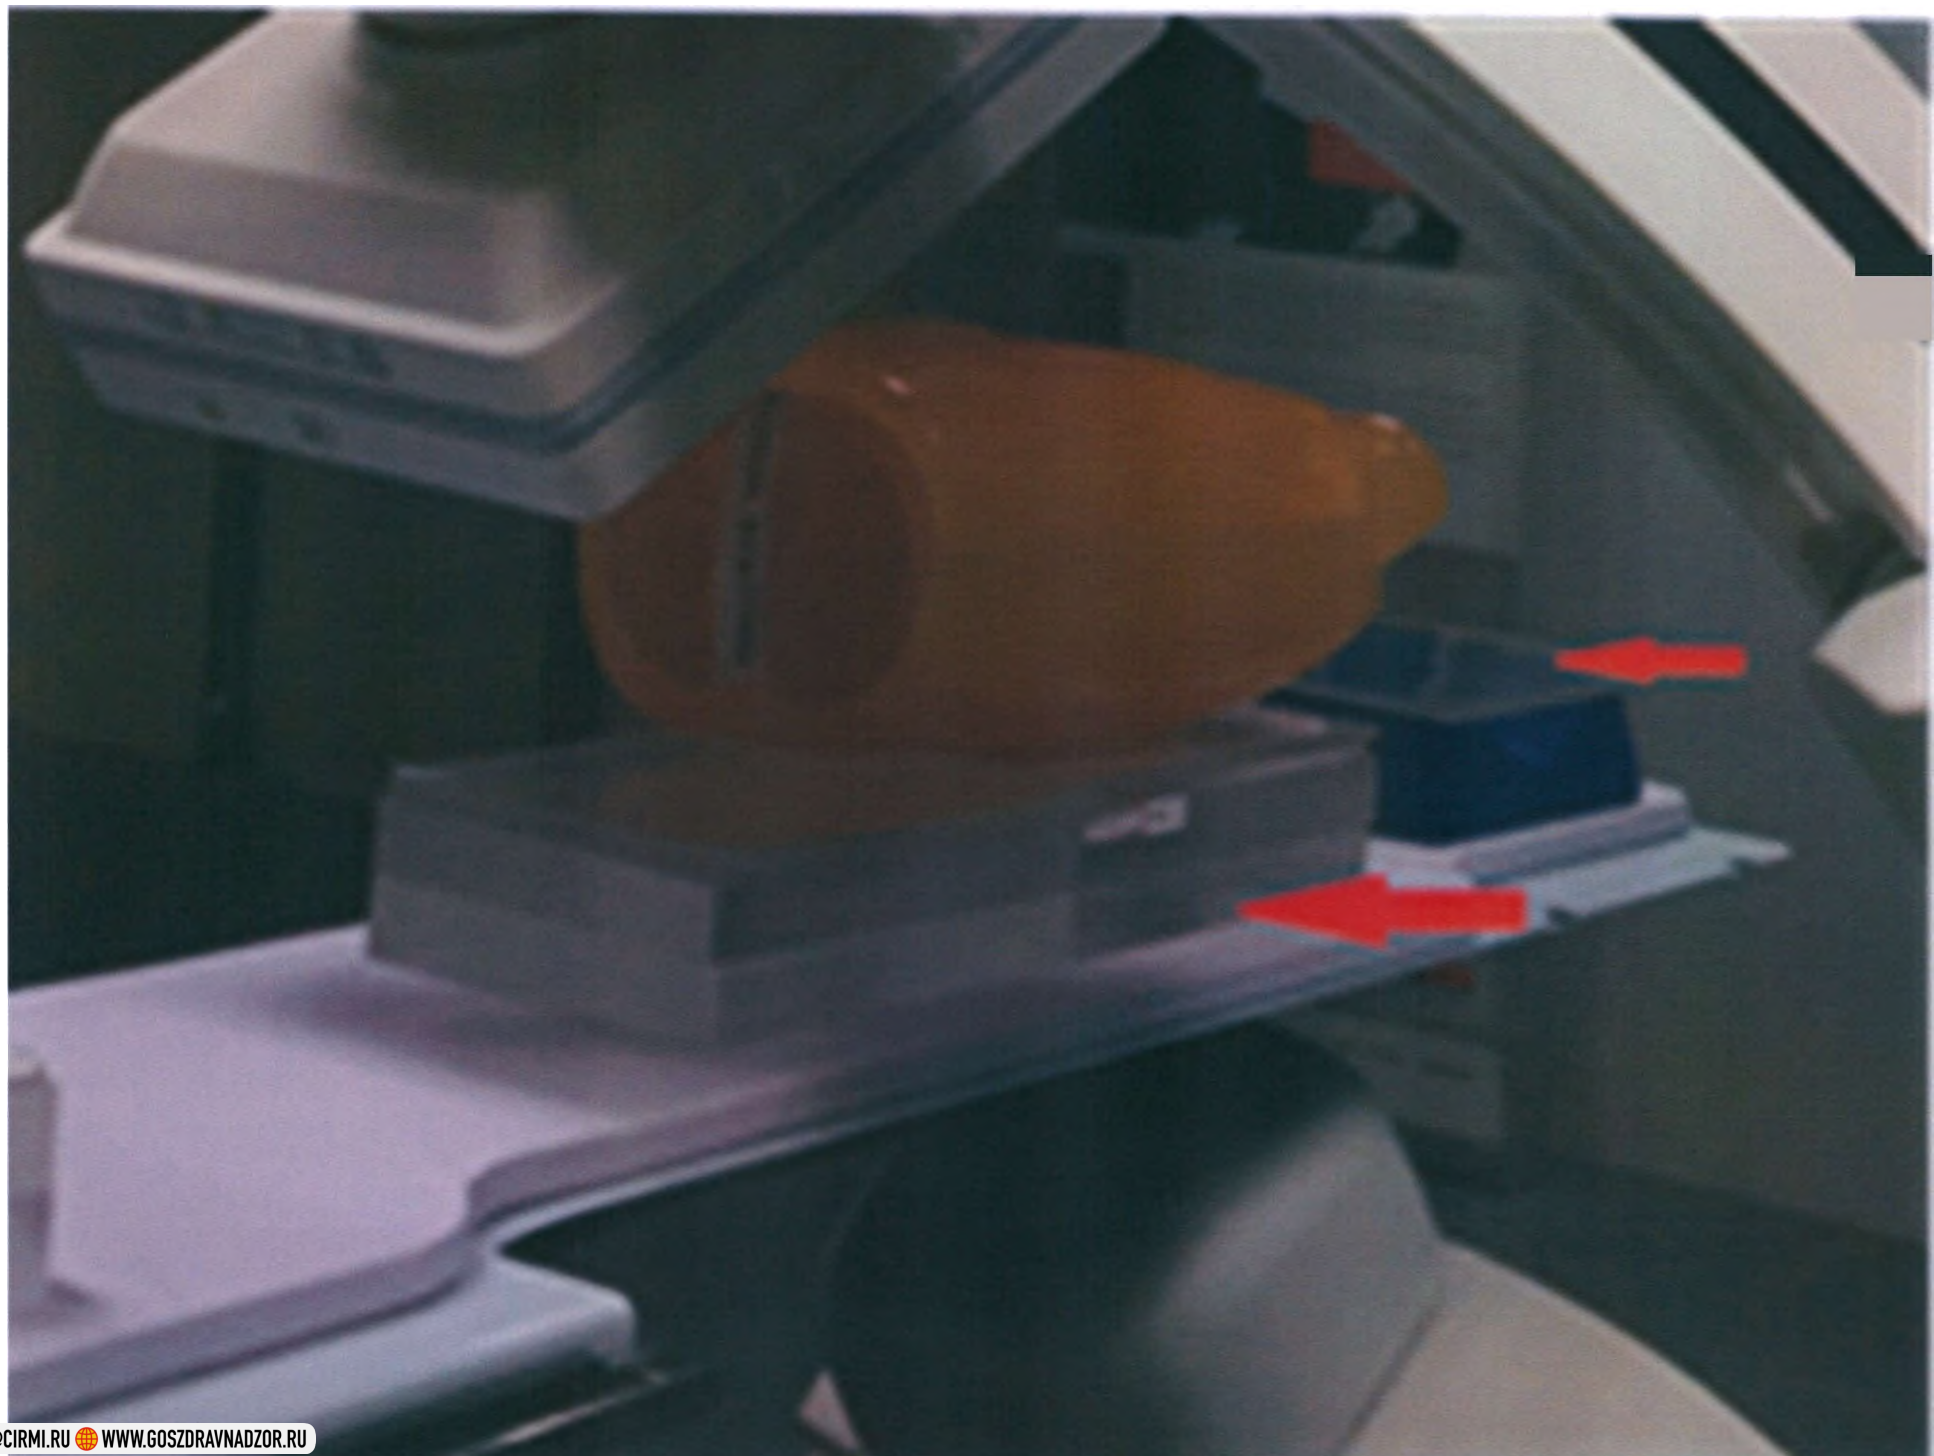

Система сосудистая ВР интервенционная ангиографическая Alphenix модели INFx-8000V/Y с принадлежностями.

Основной состав: 1. Напольный опорный модуль С-дуги модели CAS-880A.






3. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, в вариантах исполнения: - модель BLA-900A - 2 шт.




3. Устройство ограничения диагностического рентгеновского пучка, в вариантах исполнения: - модель BLA-900A/R1- 2 шт.




4. Узел рентгеновской трубки модели, в вариантах исполнения: Вариант 1: - модель DSRX-T7445GFS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония) - 2 шт.

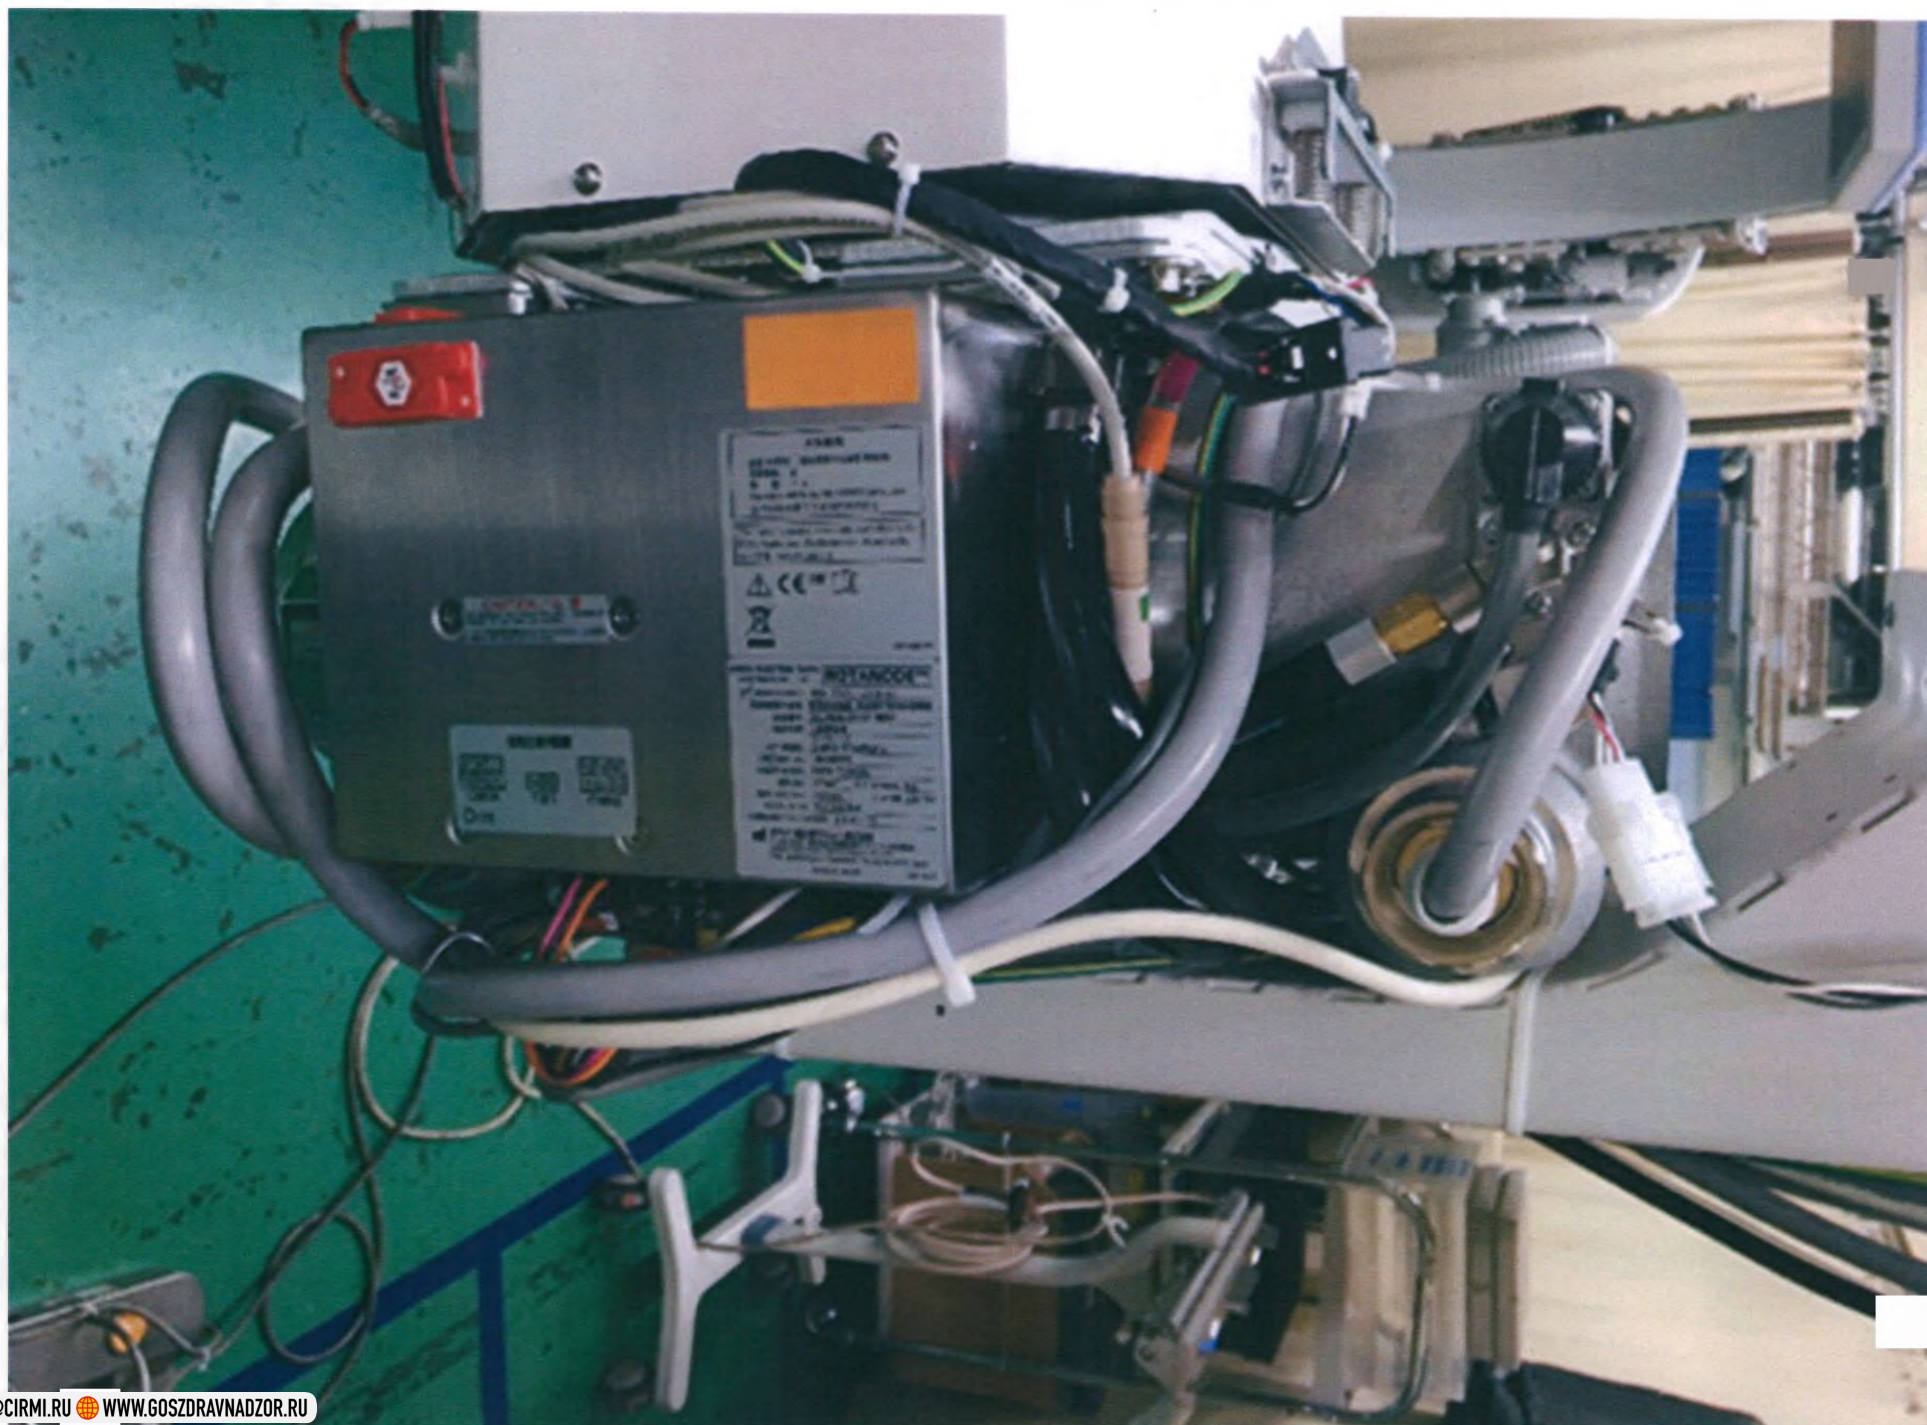

4. Узел рентгеновской трубки модели, в вариантах исполнения: Вариант 2: - модель DSRX-T7345GFS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония) - 1 шт.,

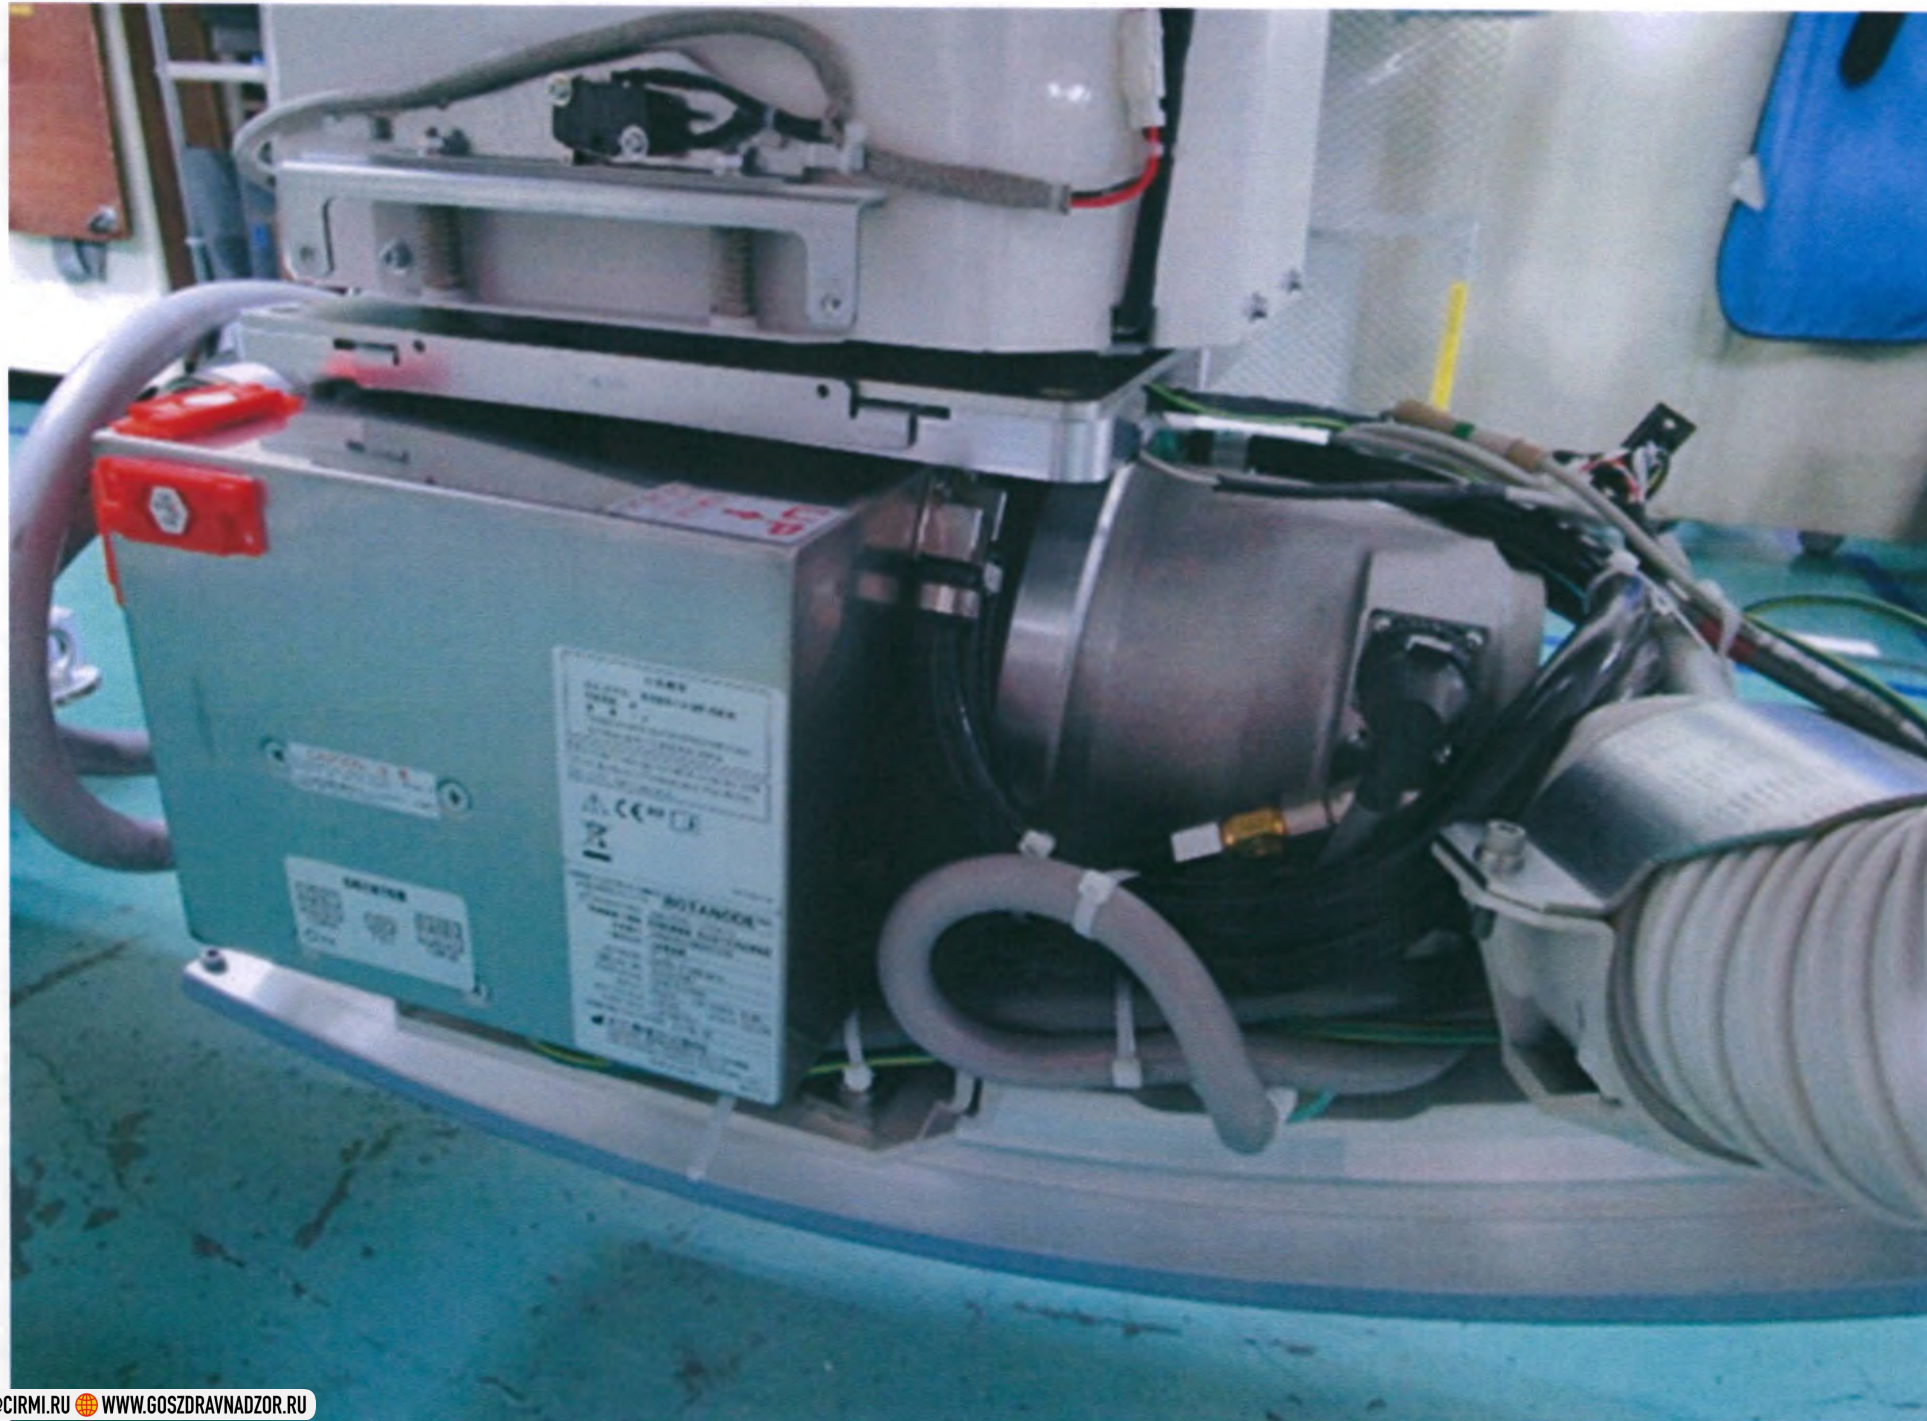


4. Узел рентгеновской трубки модели, в вариантах исполнения: Вариант 2: - модель DSRX-T7445GFS (производитель Canon electron tubes & devices, Япония) - 1 шт.

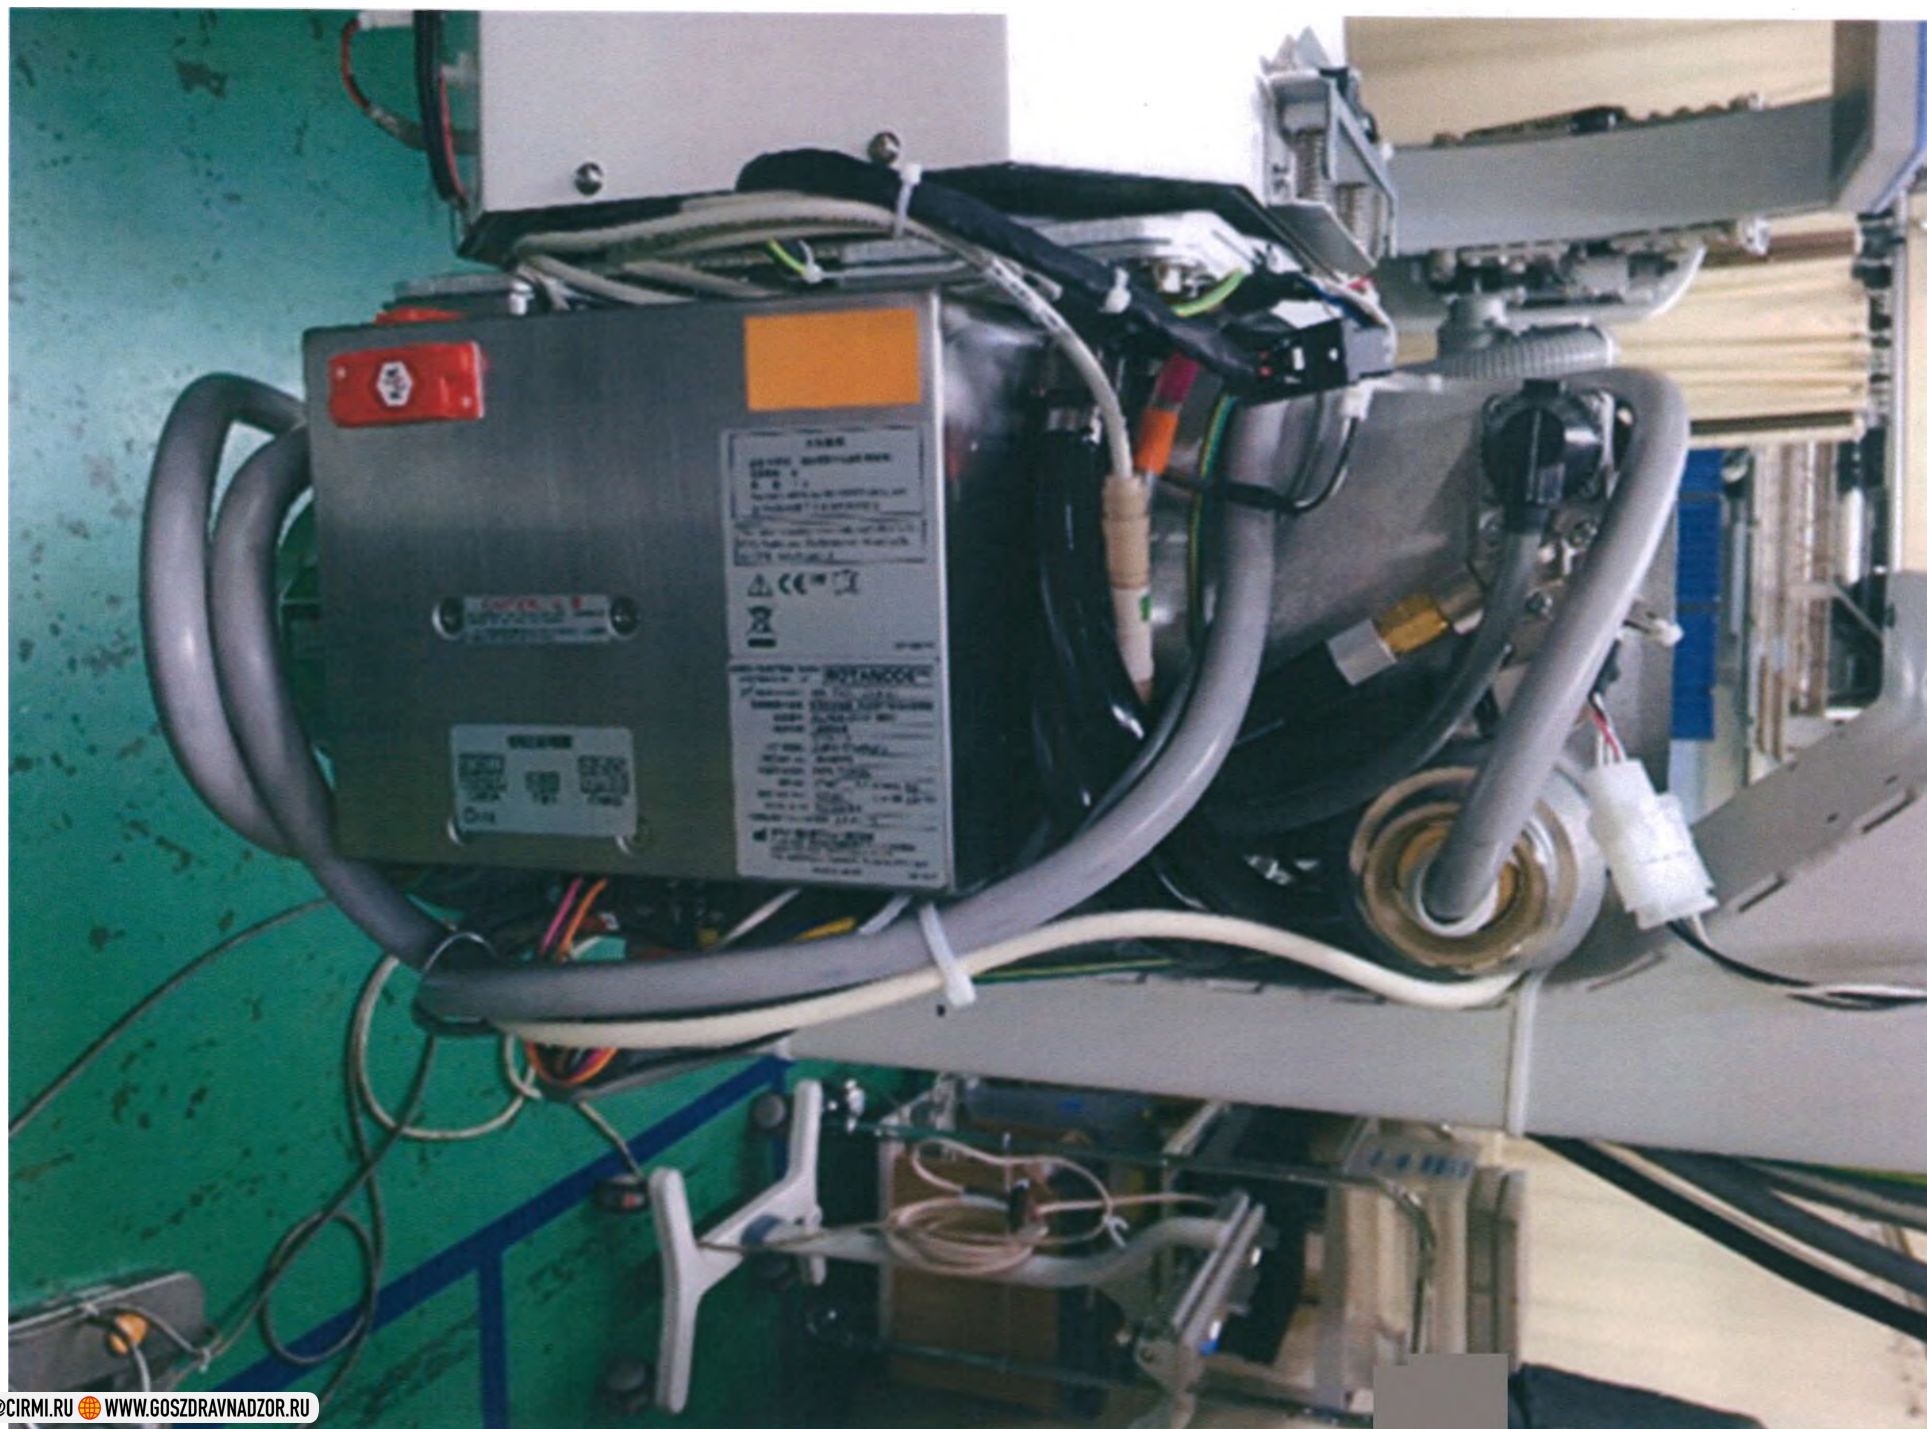

5. Скоростное пусковое устройство с вращающимся анодом (производитель Canon electron tubes & devices, Япония) - 2 шт.




6. Комплект кабелей для рентгеновской трубки - 2 комплекта.

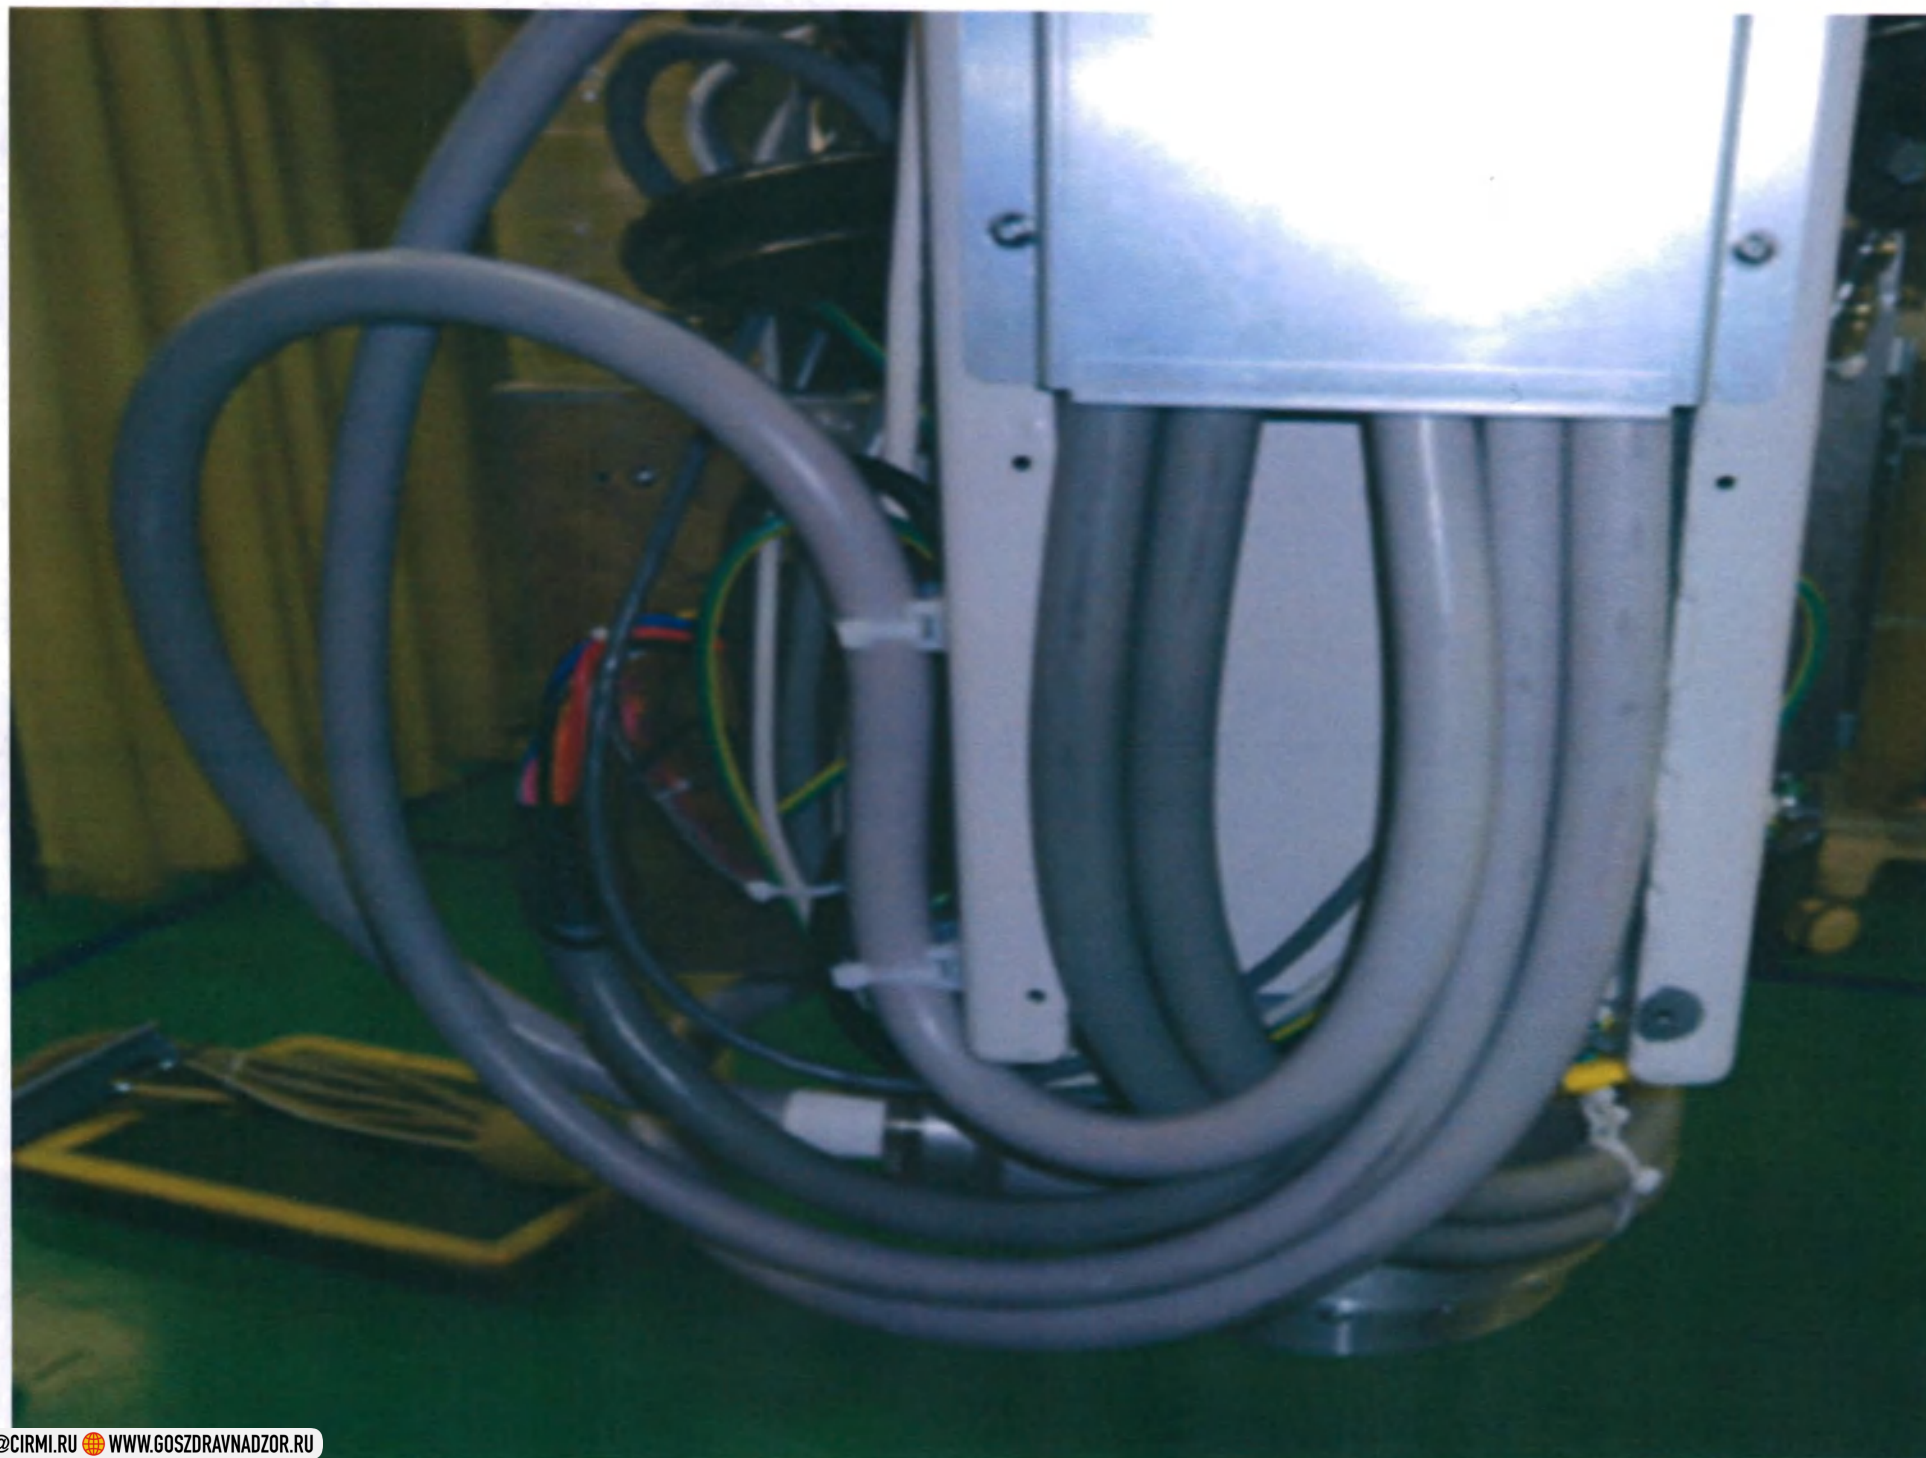

7. Теплообменник с водяным охлаждением (производитель Canon electron tubes & devices, Япония) - 2 шт.



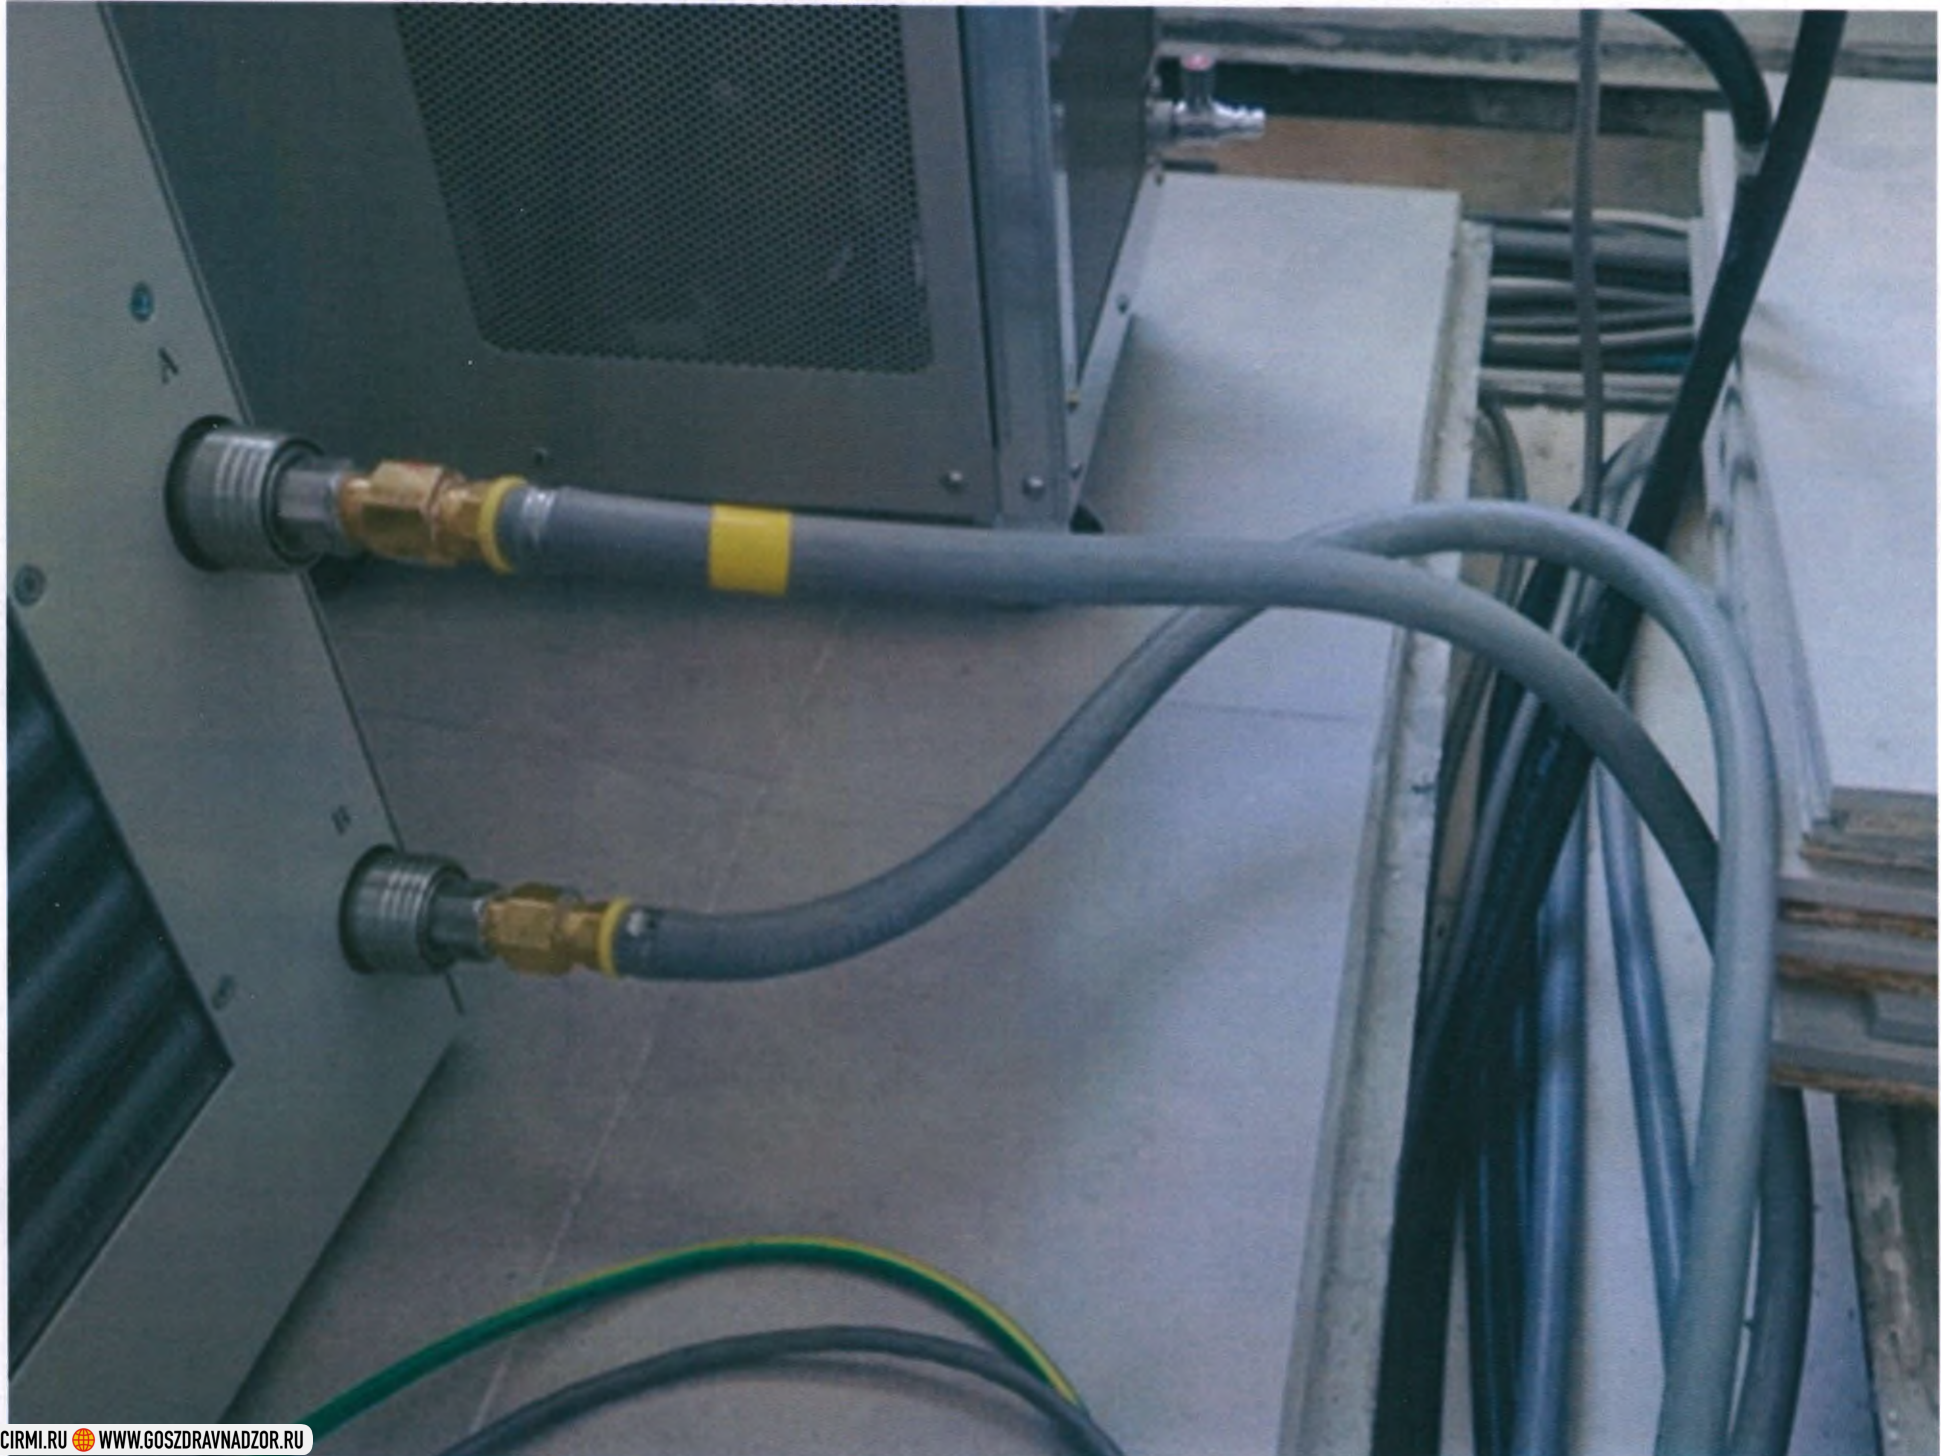




10. Рентгеновский плоскопанельный детектор с водяным охлаждением, в вариантах исполнения: Вариант 1: - 12-дюймовый FPD стандартный) - 2 шт.



Блок водяного охлаждения



Основной блок 12-дюймового FPD

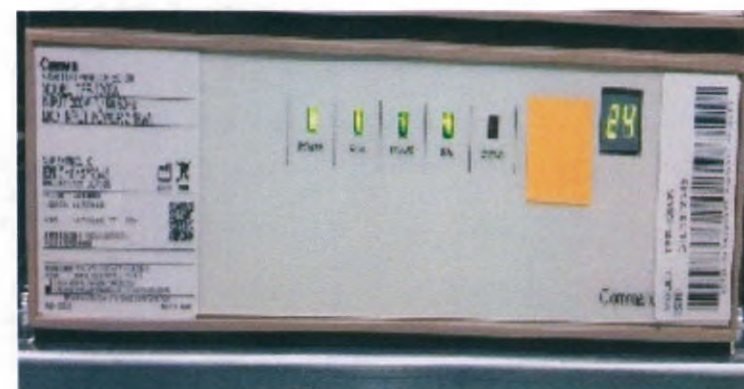

Командный процессор


10. Рентгеновский плоскопанельный детектор с водяным охлаждением, в вариантах исполнения: Вариант 2: - 12-дюймовый FPD стандартный) - 1 шт.



Блок водяного охлаждения



Основной блок 12-дюймового FPD

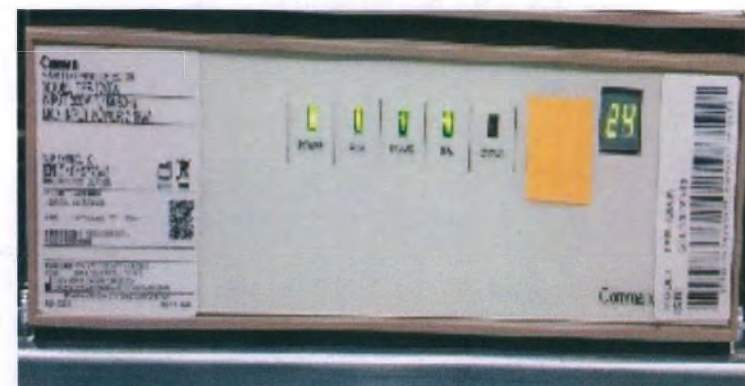


Командный процессор

10. Рентгеновский плоскопанельный детектор с водяным охлаждением, в вариантах исполнения: Вариант 2: - FPD 12 x 16 дюймов - 1 шт.



Блок водяного охлаждения

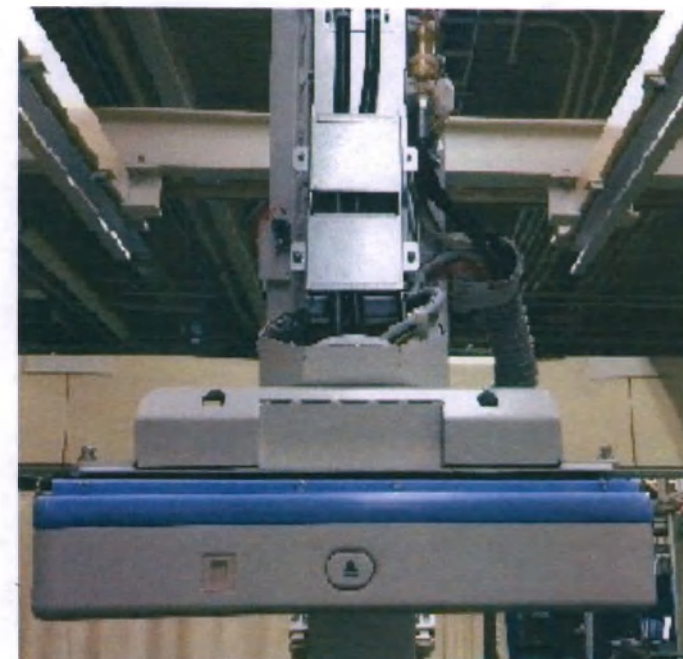

Основной блок FPD 12x16 дюймов




Командный процессор

10. Рентгеновский плоскопанельный детектор с водяным охлаждением, в вариантах исполнения: Вариант 3: - 12-дюймовый FPD (высокой четкости) - 2 шт.



Блок водяного охлаждения

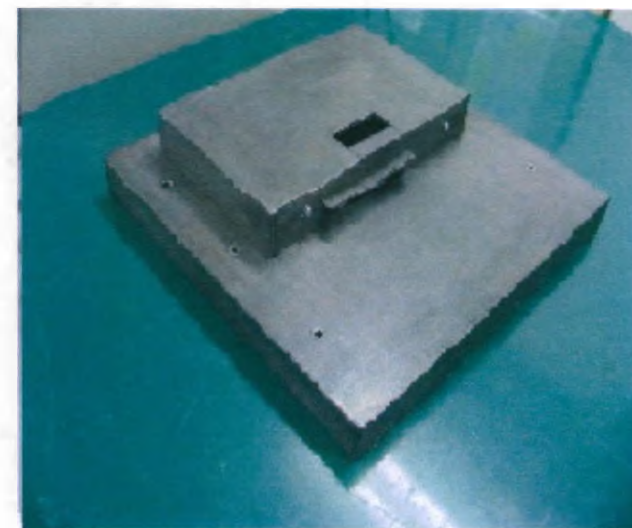

Основной блок 12-дюймового FPD




Командный процессор

11. Боковая консоль стола (для двухпроекционной системы).







Установлены внутри
шкафа управления
CAS-880A

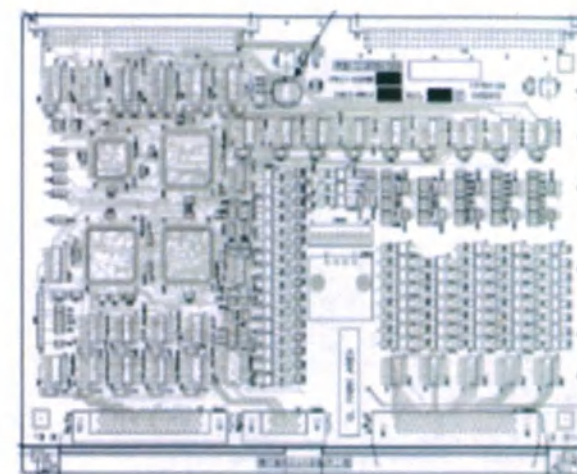

Электронная плата Hyper IO pcb

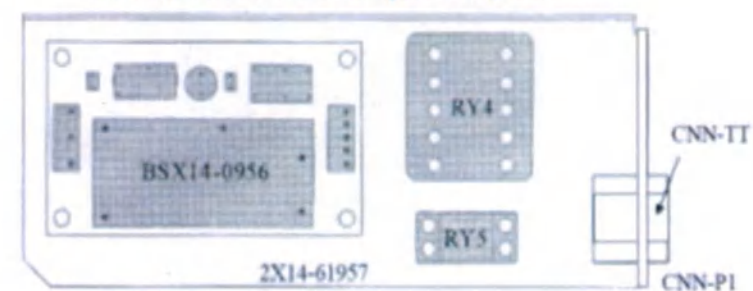


Интерфейсный блок

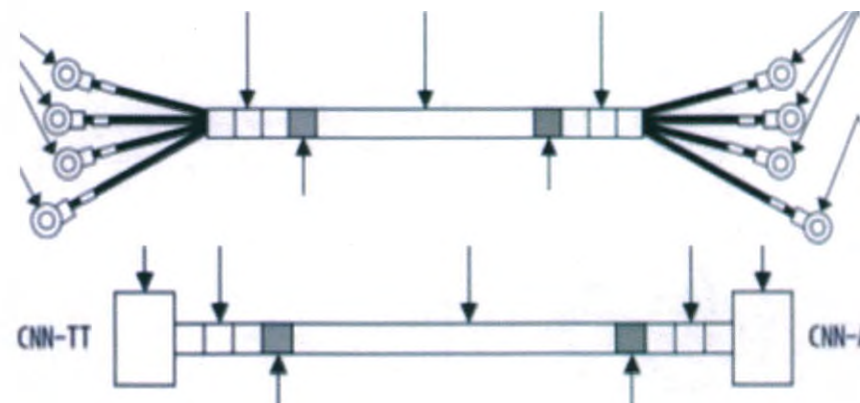


Интерфейсные кабели

13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: - основная часть стола для катетеризации;

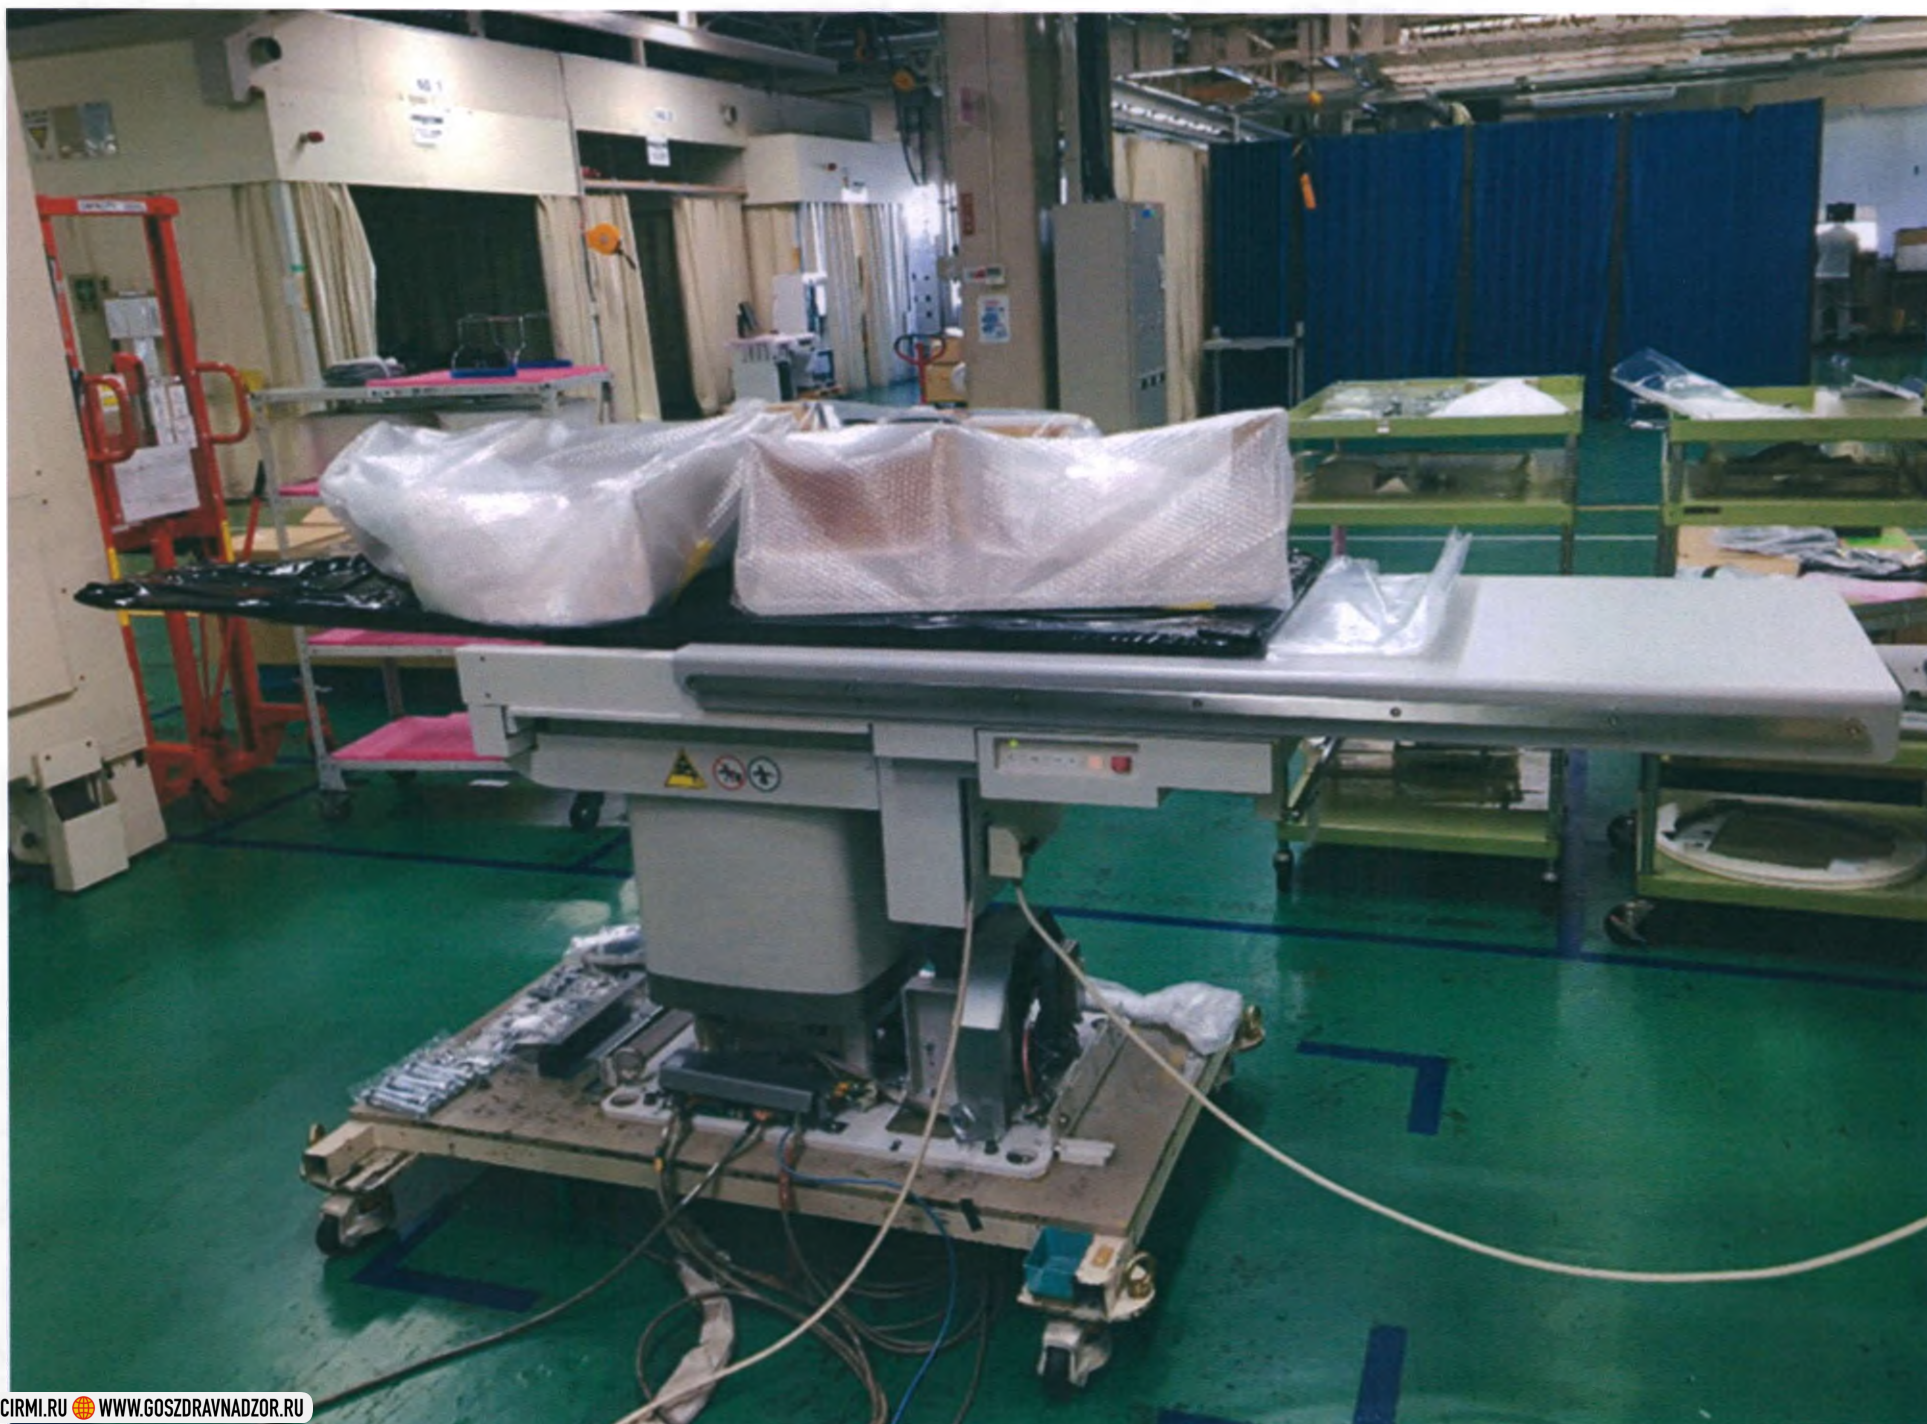


13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-850В, в составе: - стандартная накладка для деки стола;

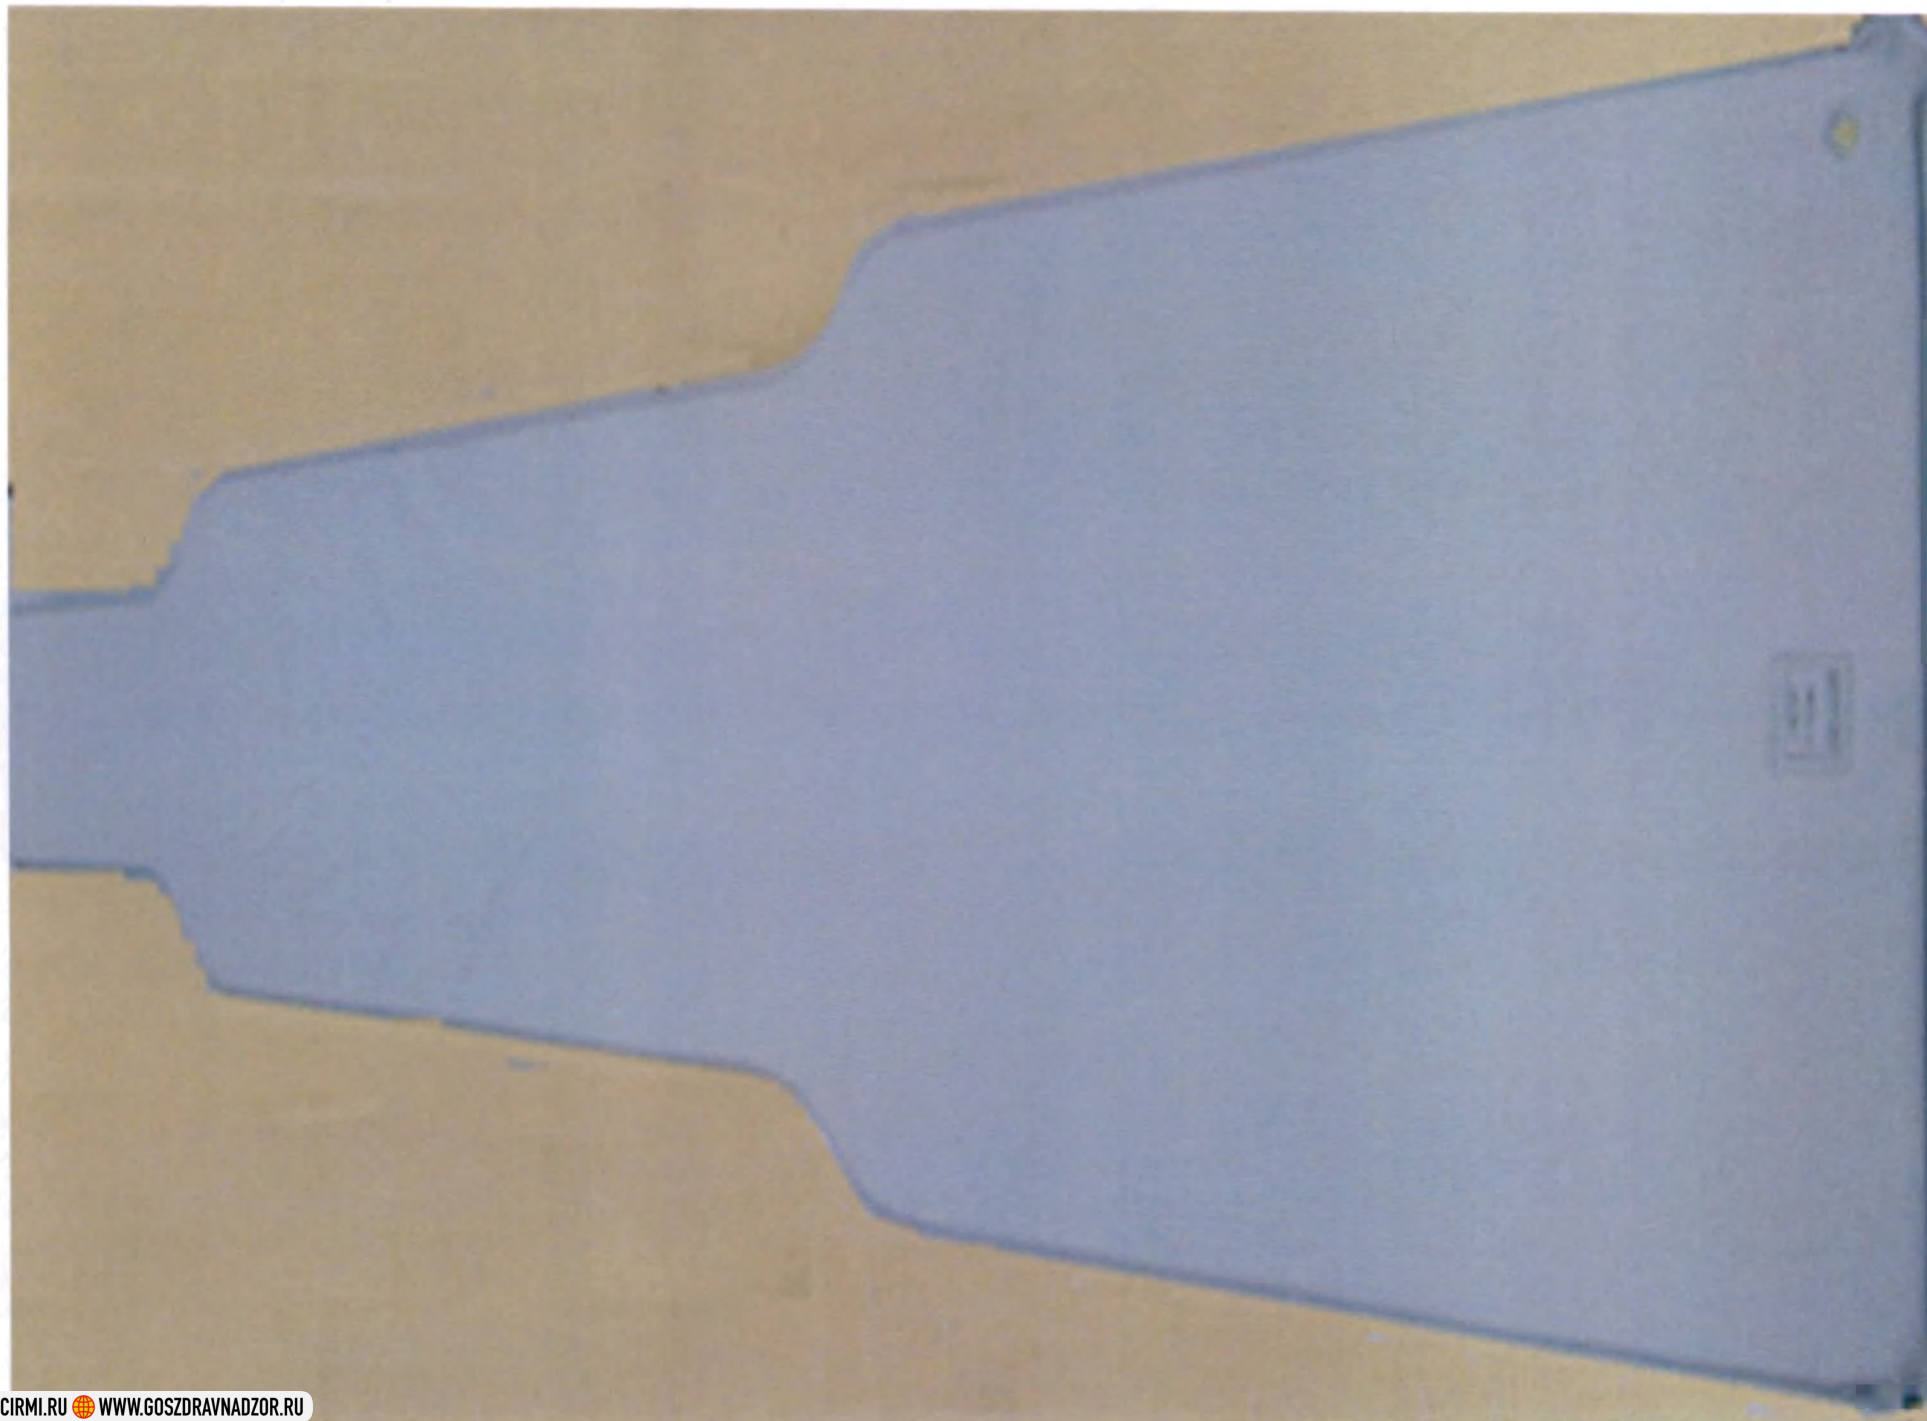

13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель CAT-850B, в составе: - стойка для капельной инфузии;





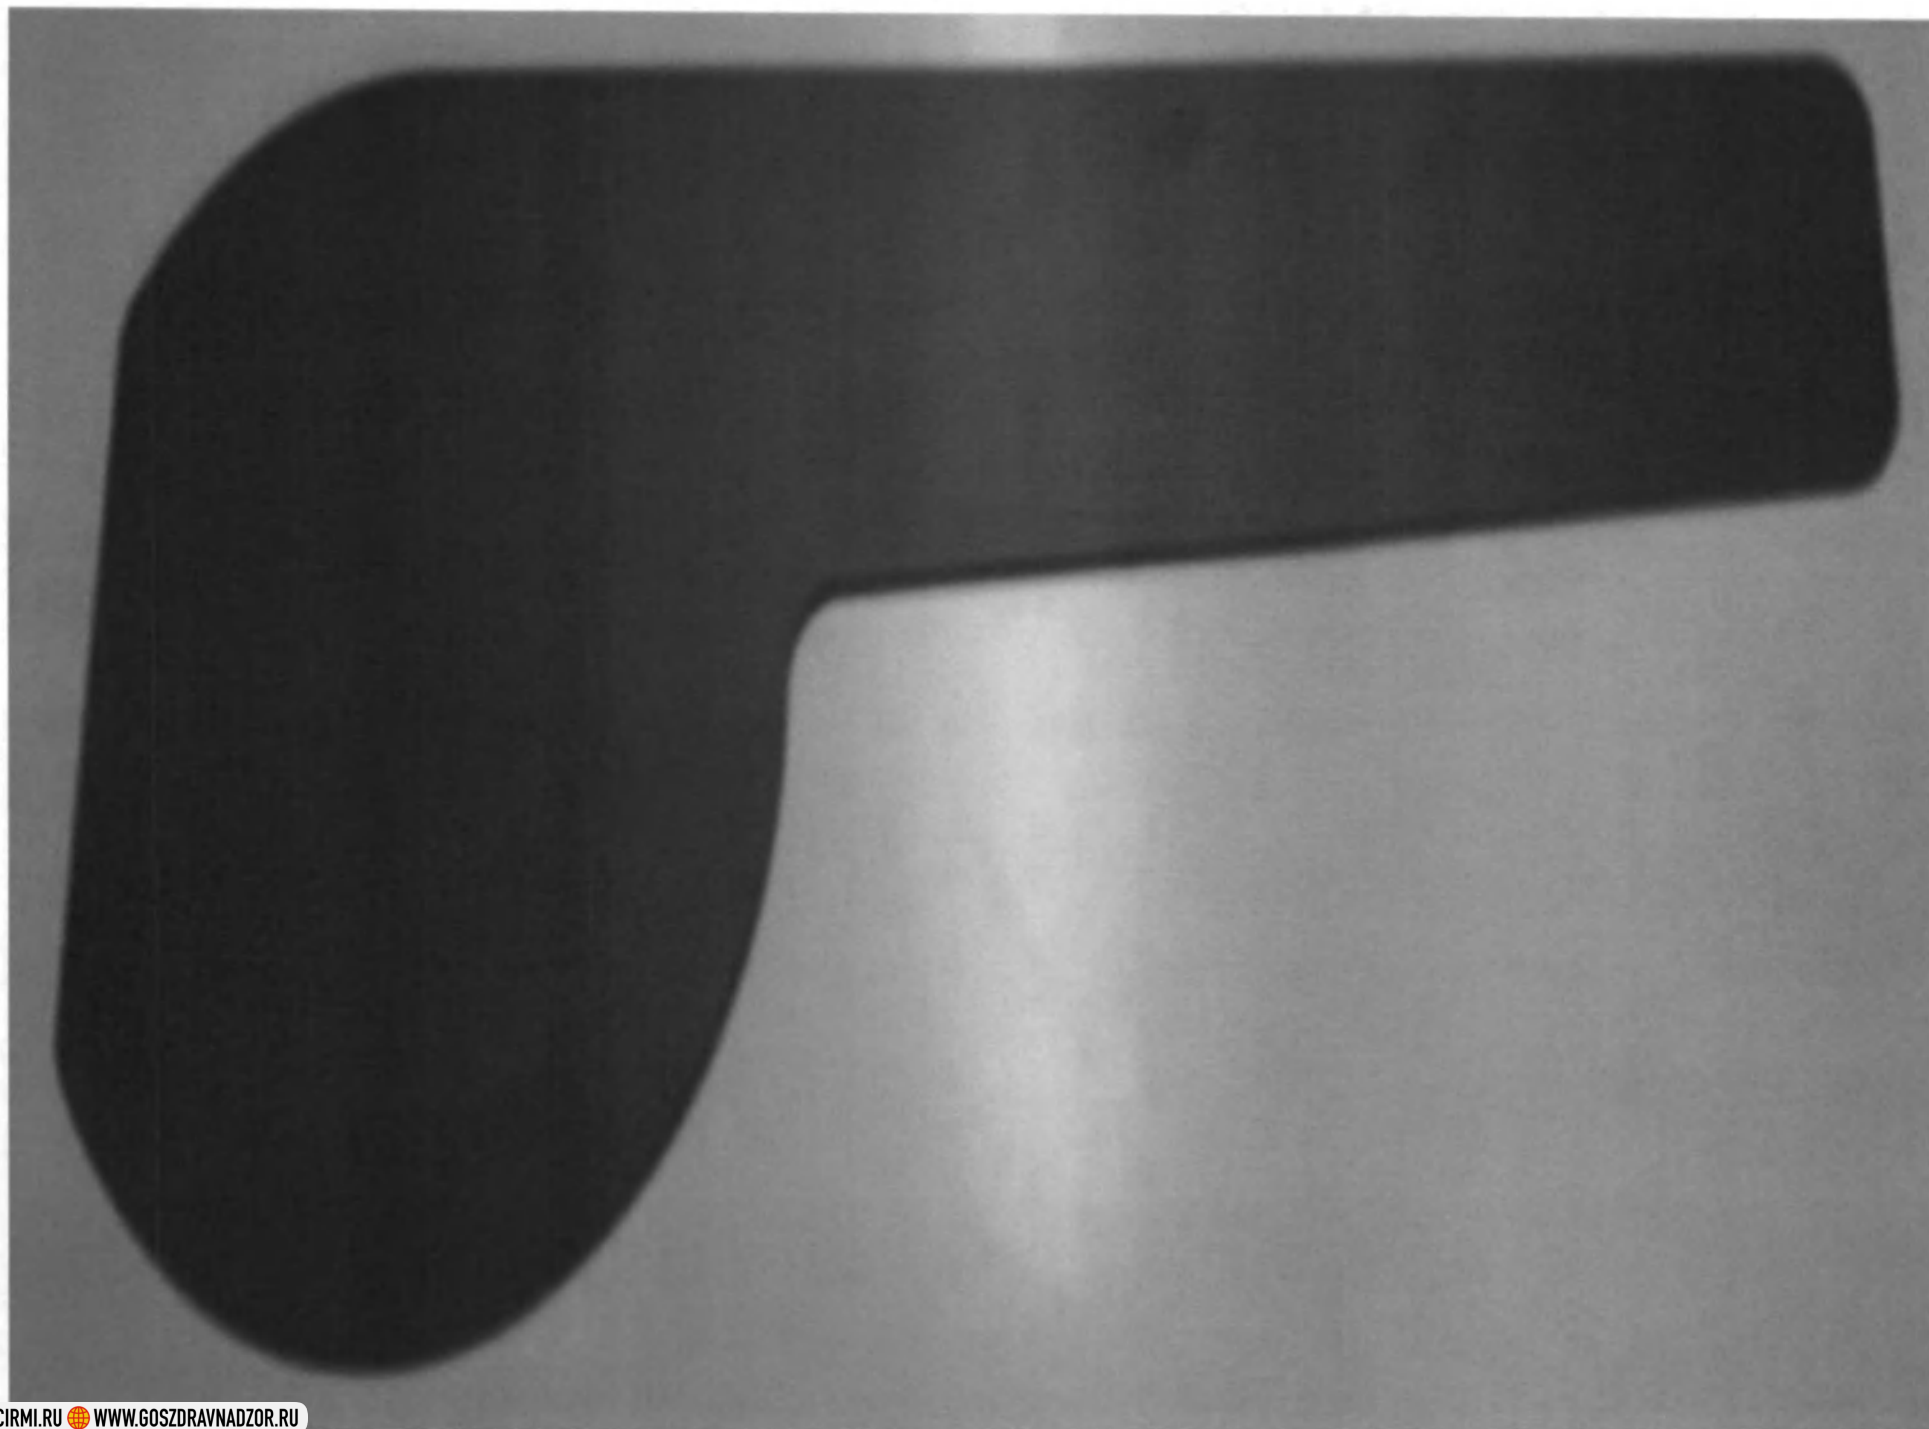

13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель CAT-880B, в составе: - основная часть стола для катетеризации;



13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - пульт управления столом;



13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - стойка для капельной инфузии;



13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - стандартная накладка для деки стола;




13. Стол для катетеризации, в вариантах исполнения: Модель САТ-880В, в составе: - ремень для иммобилизации пациента - не более 2-х штук.




14. Ножной переключатель (в кабинете сканирования) для двухпроекционной системы.



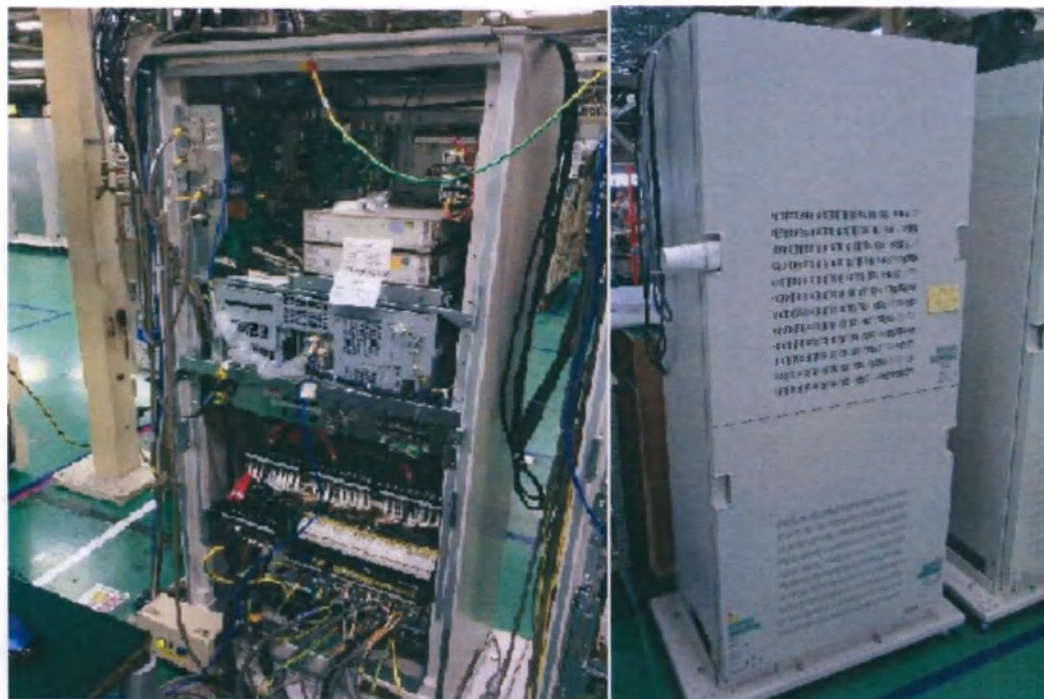

Системный шкаф

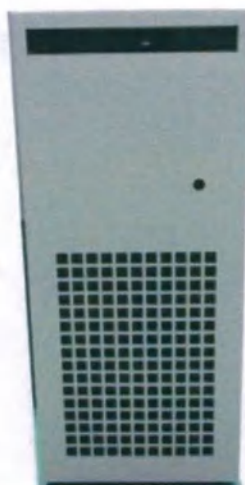

Компьютер
консоли системы




Блок управления



Программное обеспечение
основное

16. Консоль системы, в составе: - комплект клавиатуры;

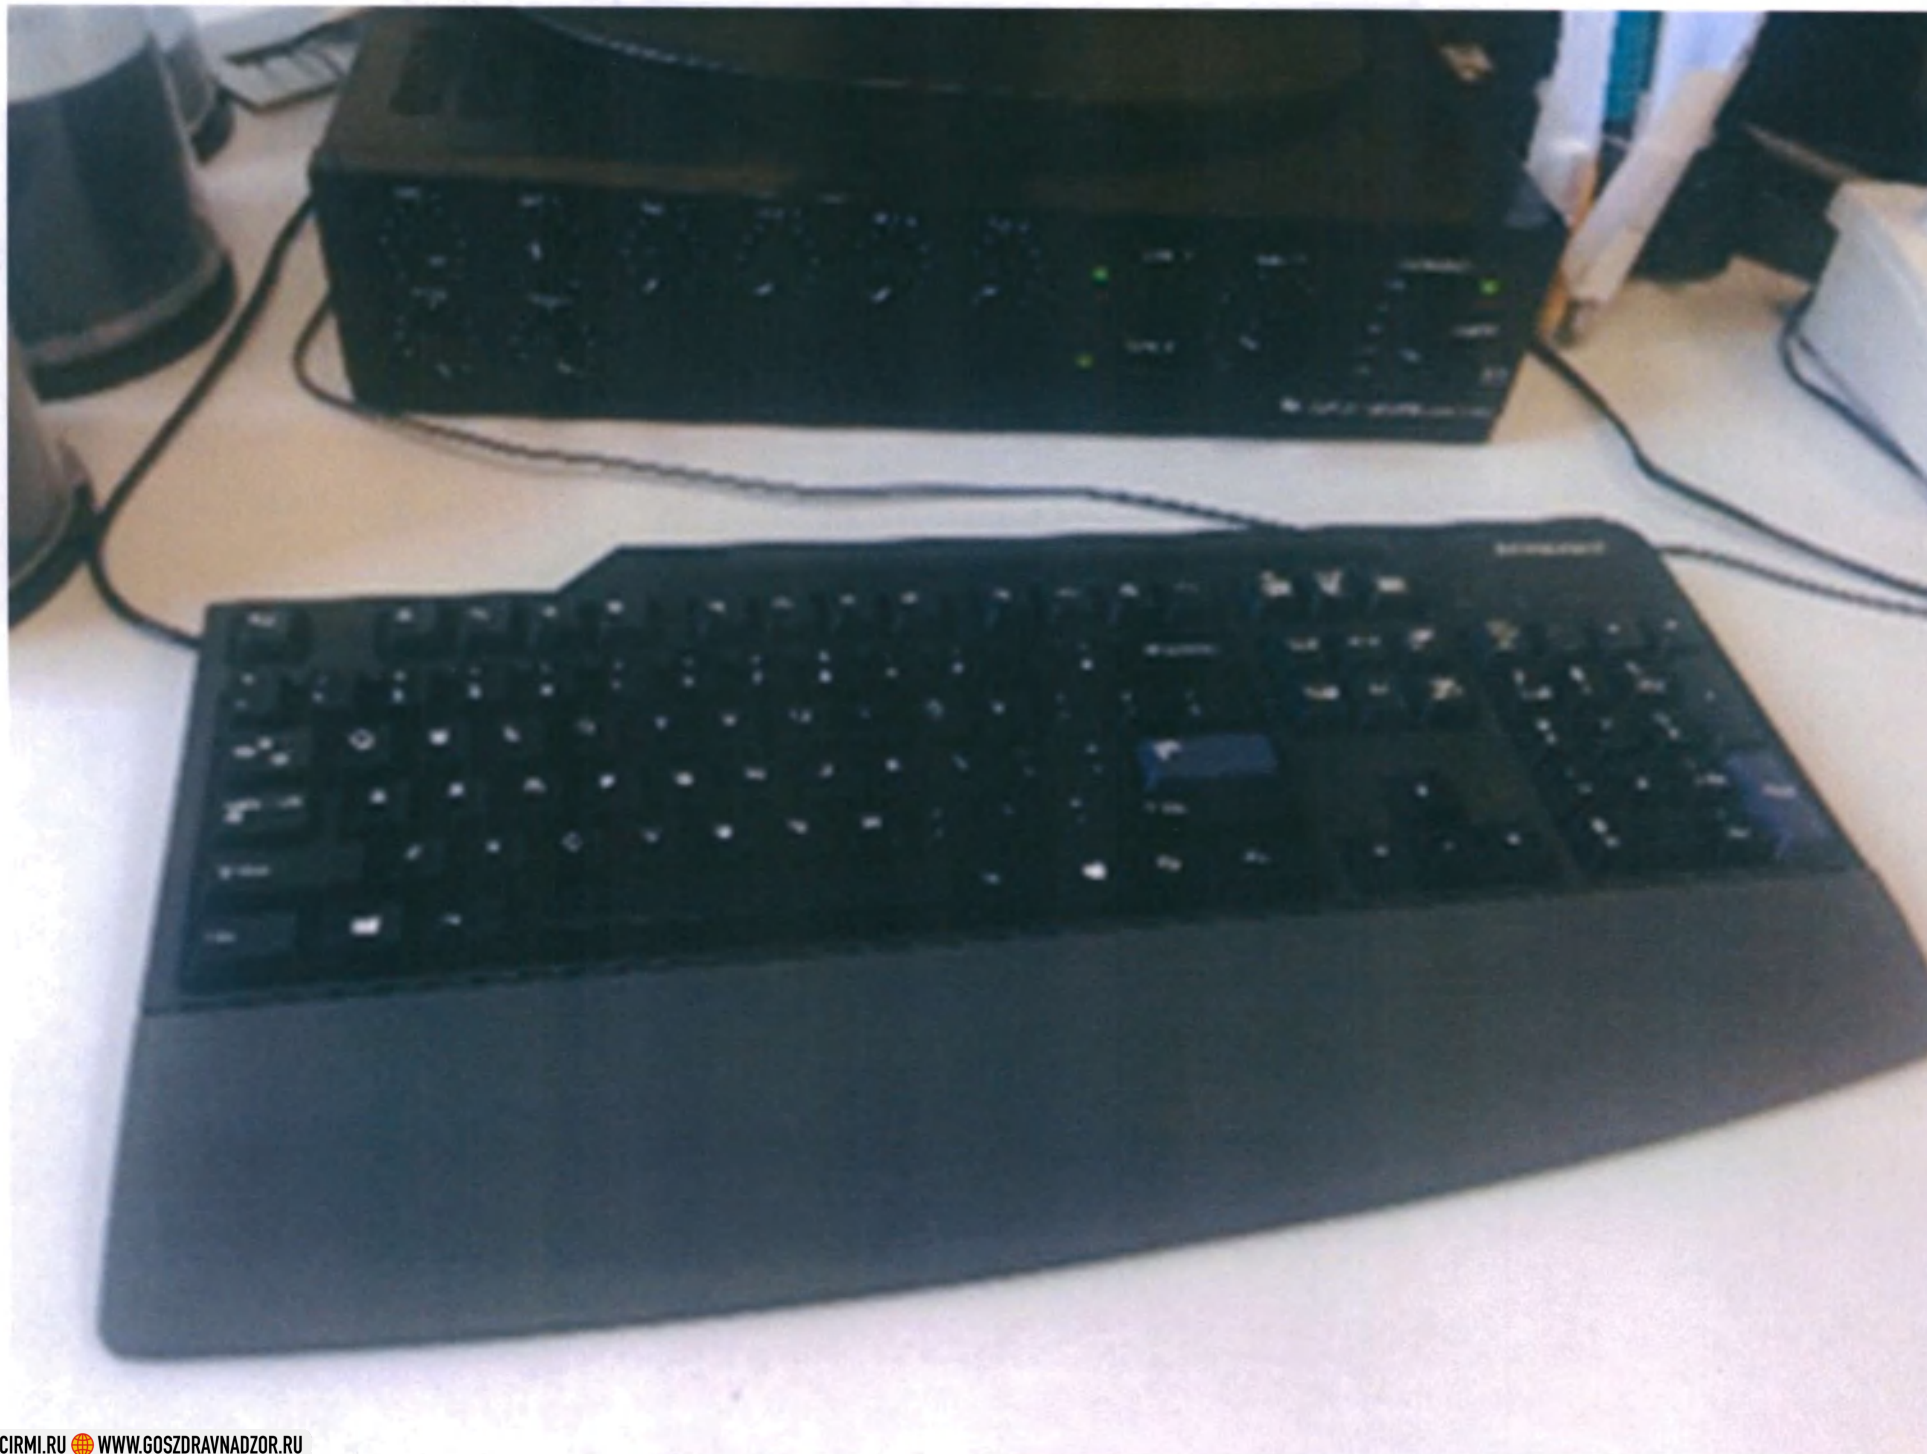



16. Консоль системы, в составе: - монитор системы; - блок включения электропитания.




17. Ножной переключатель для рентгеноסקопии в кабинете управления (для двухпроекционной системы).










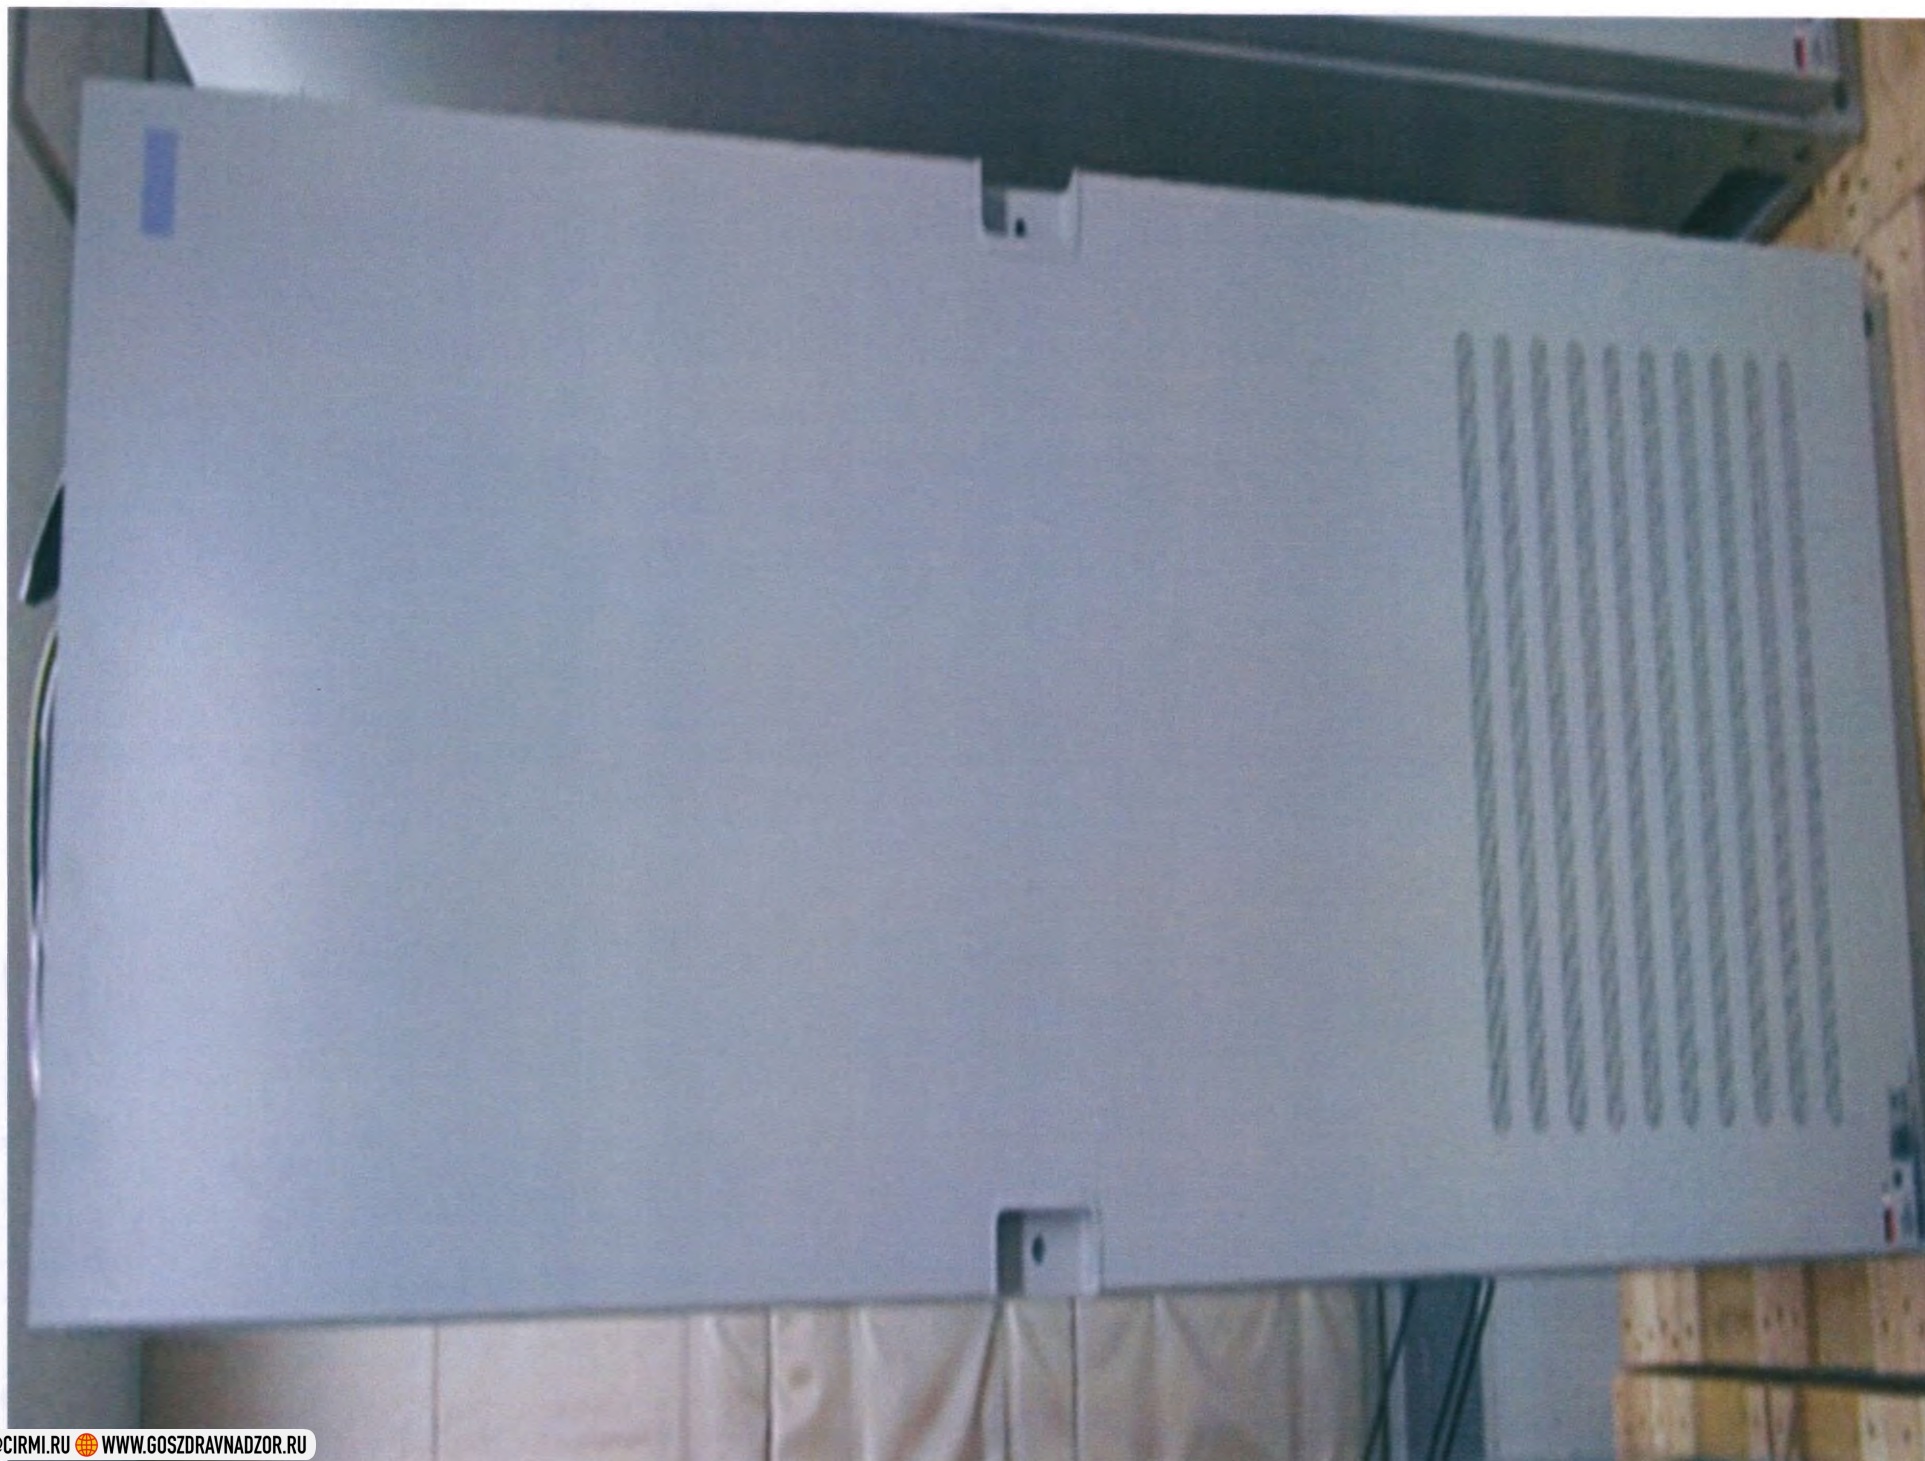


21. Подвесное устройство для мониторов.

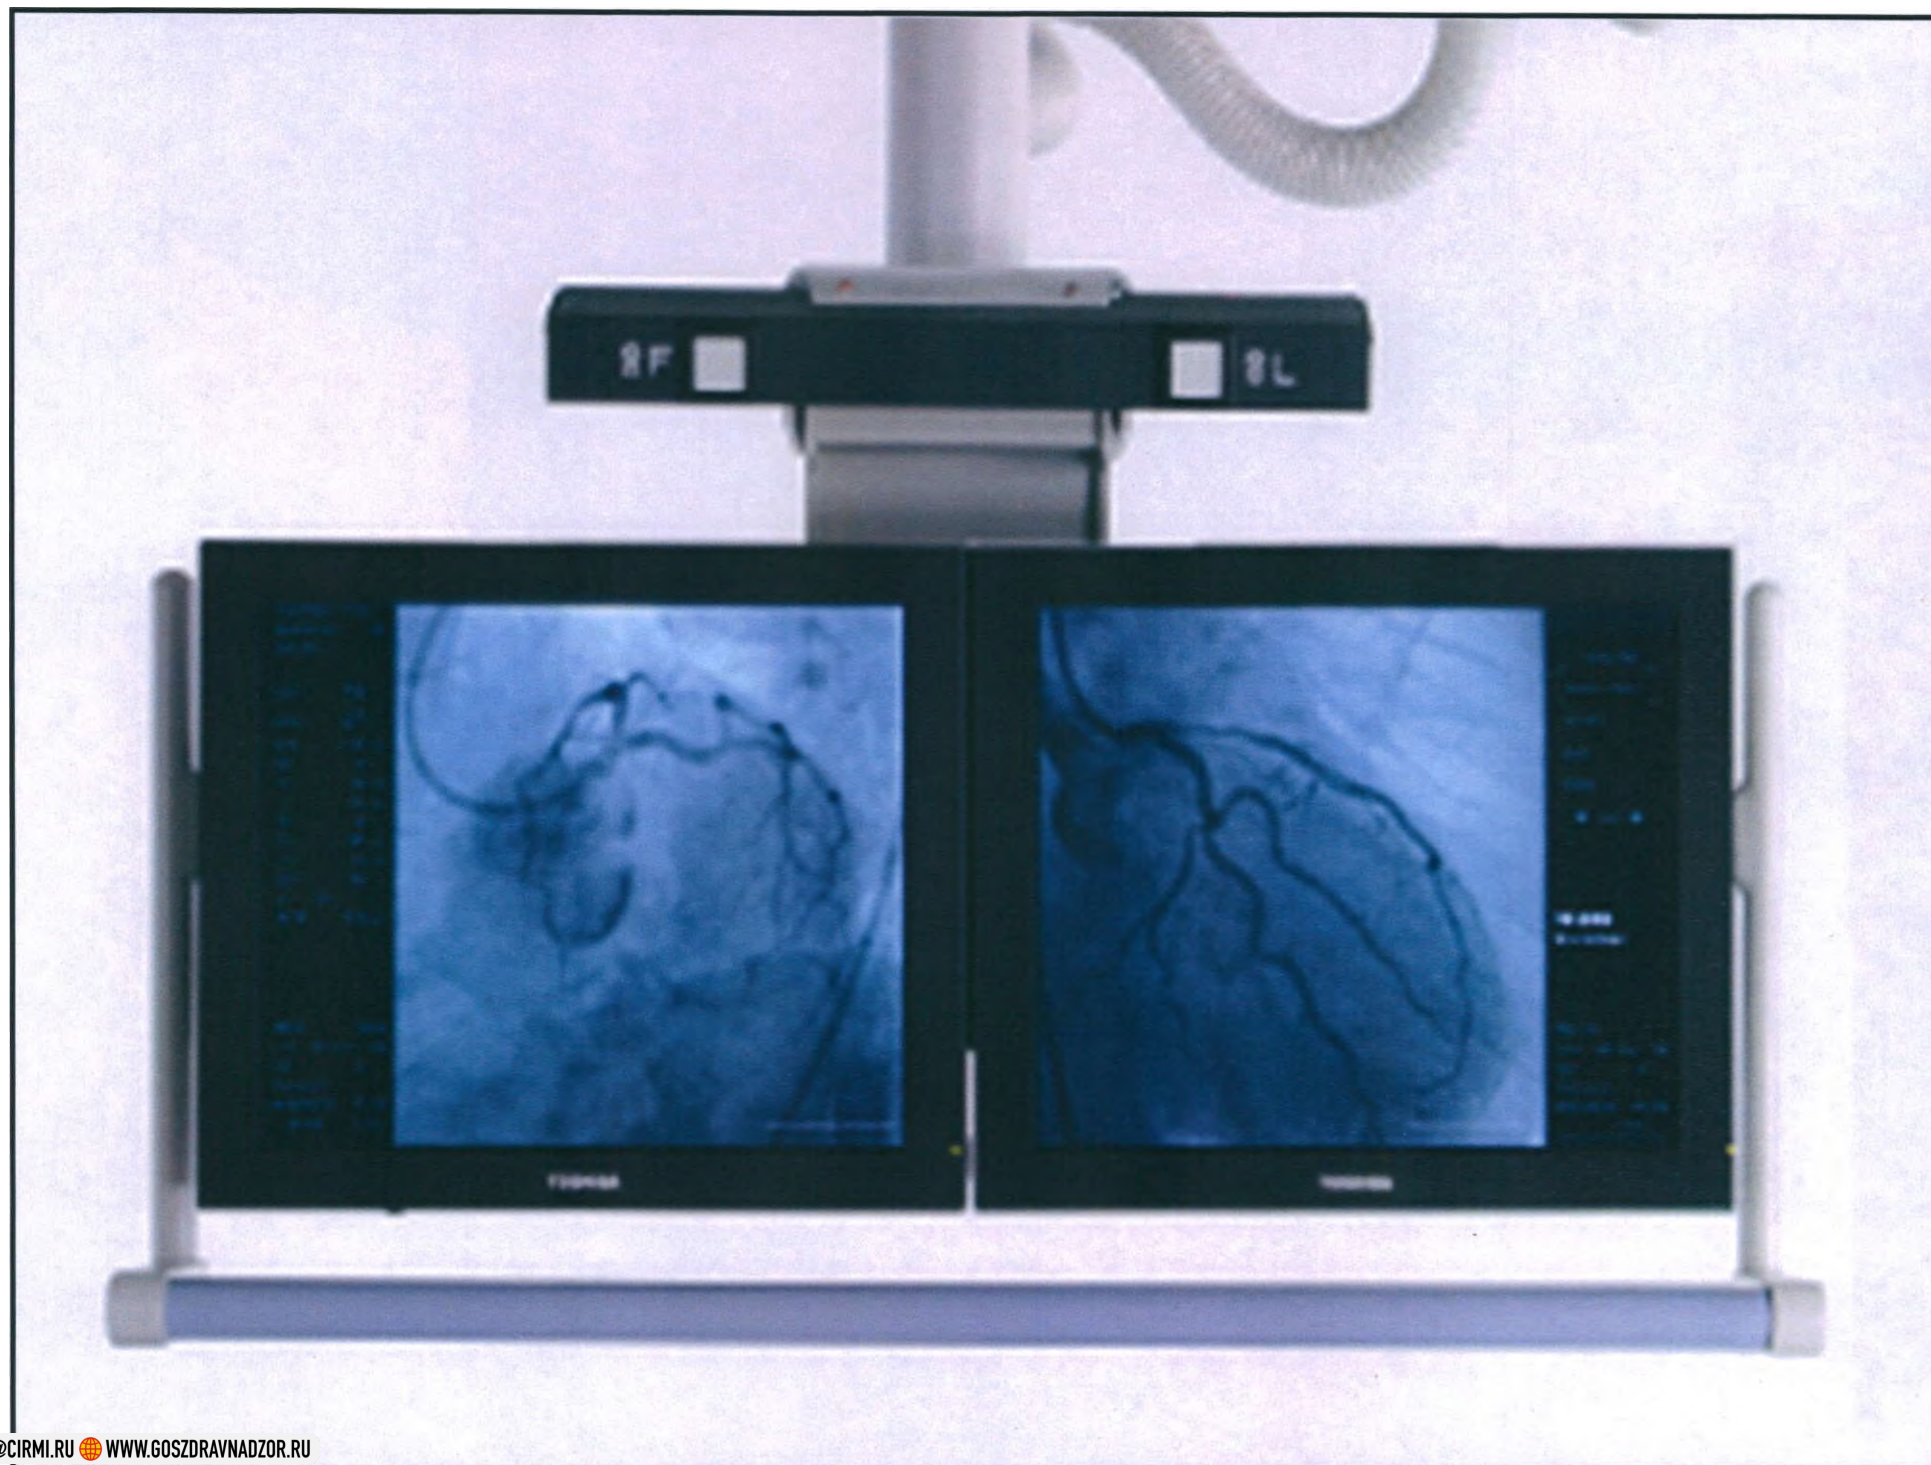

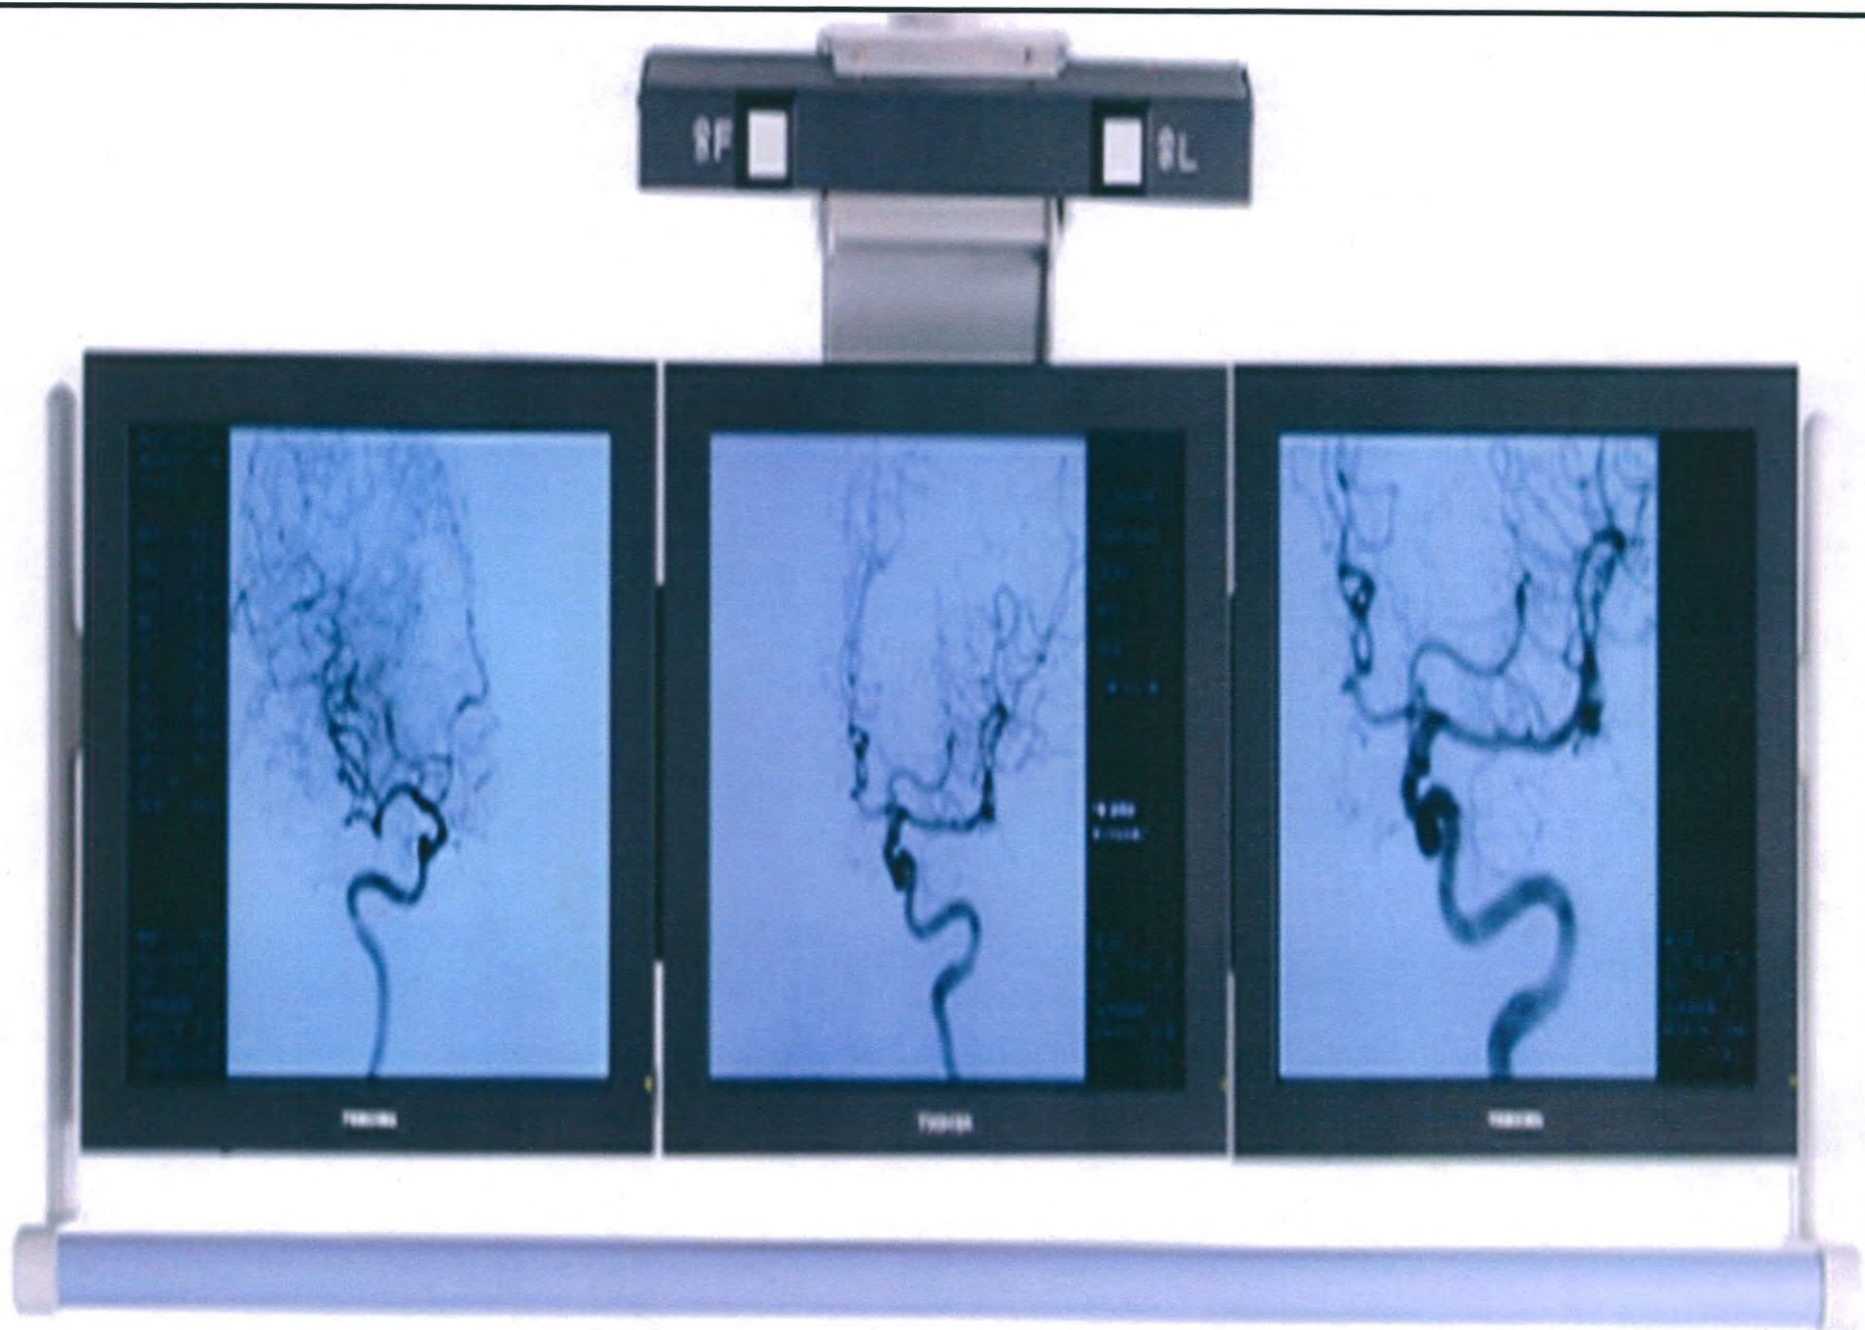

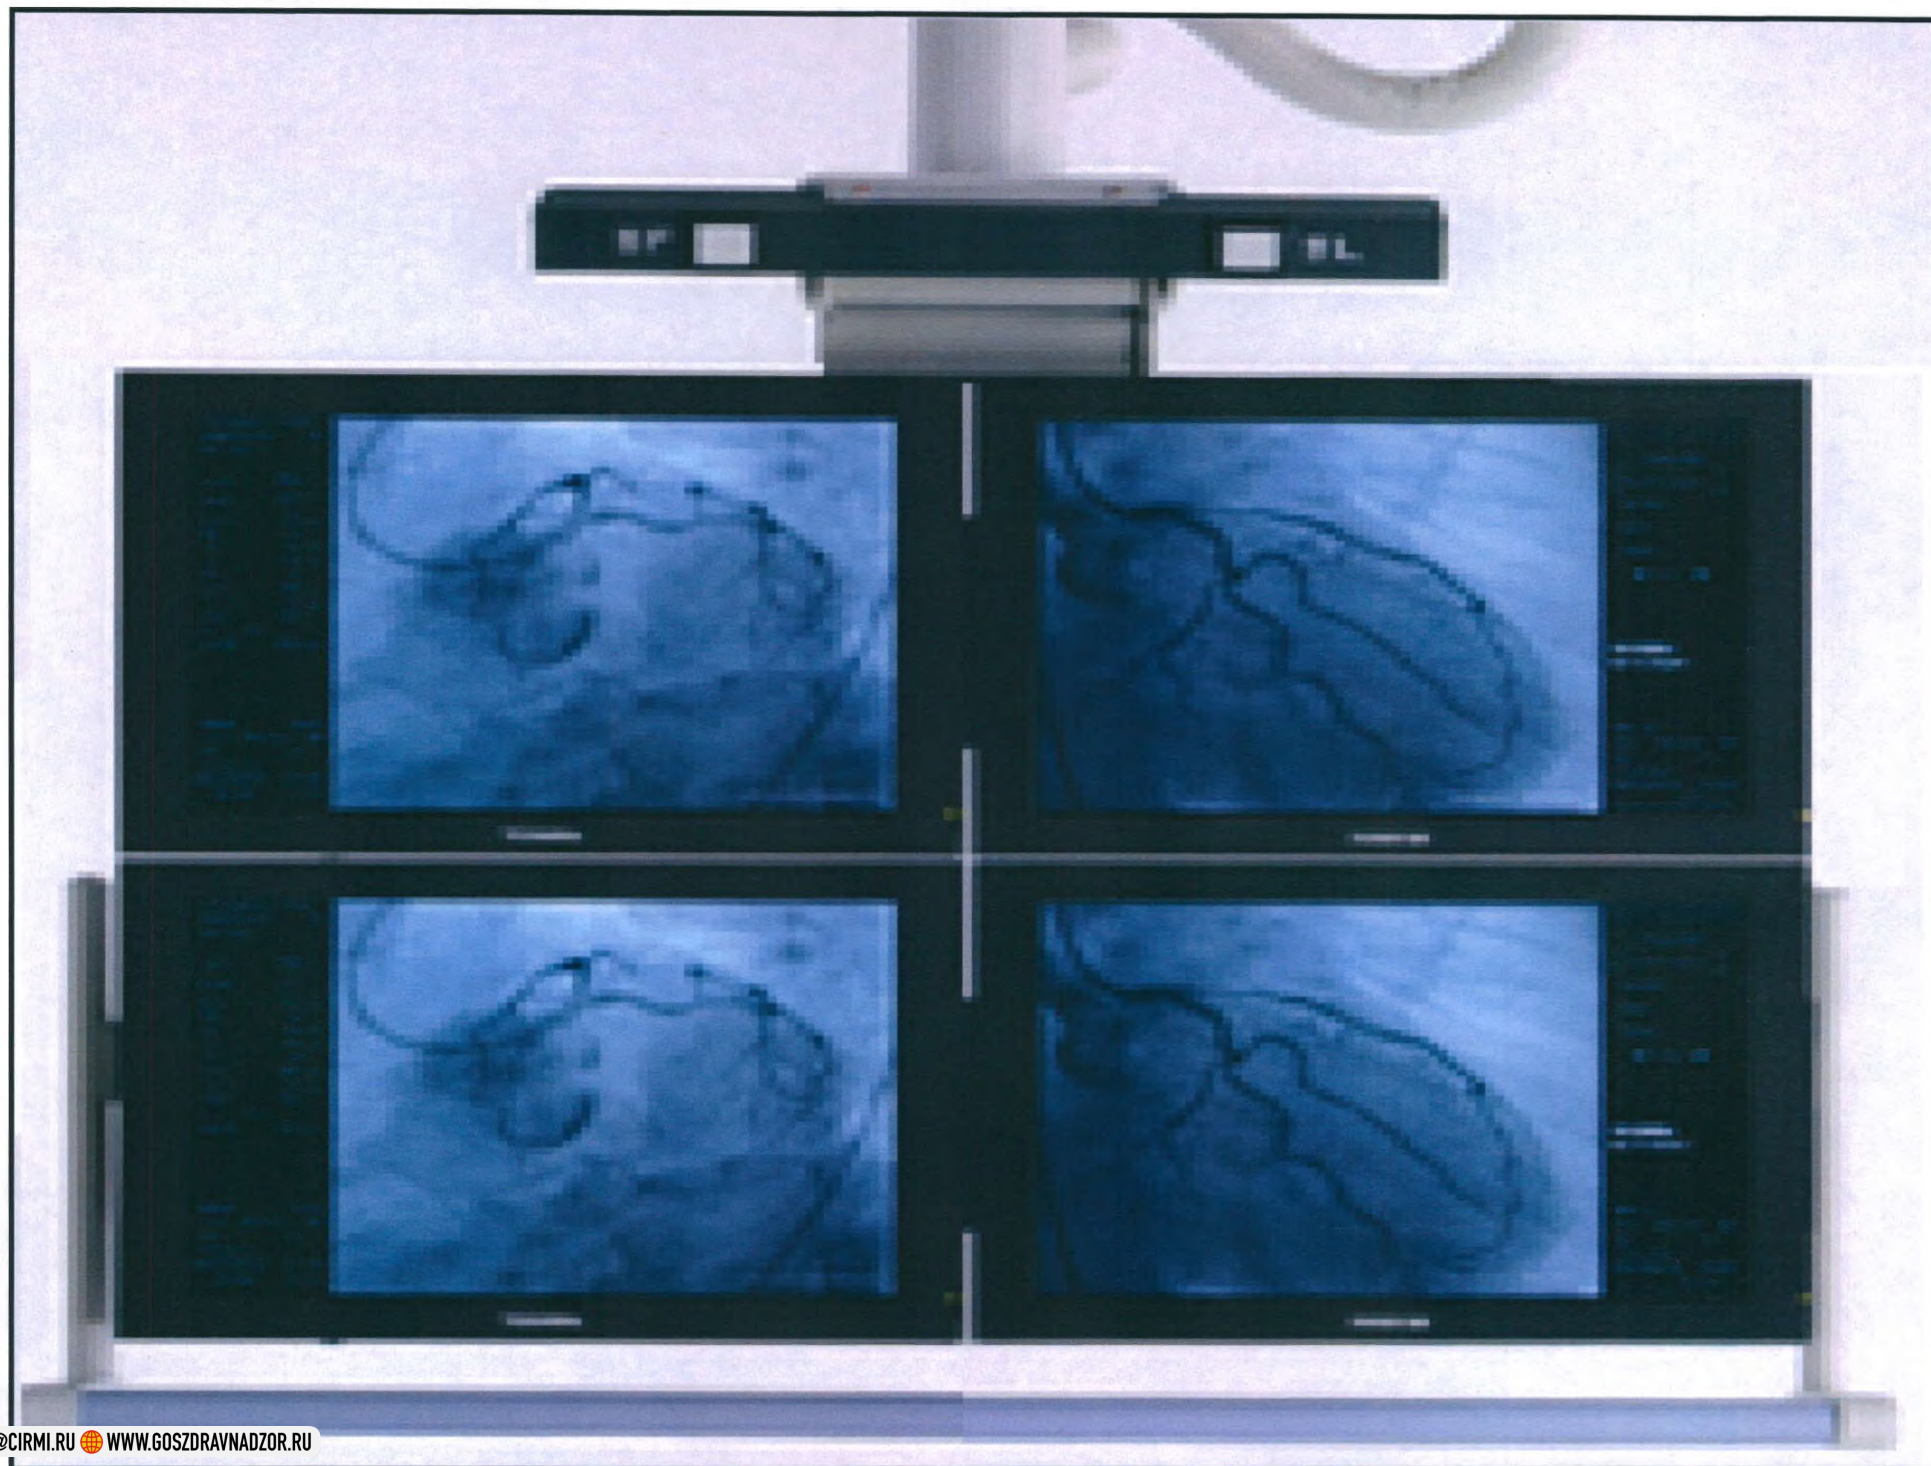


21. Подвесное устройство для мониторов.

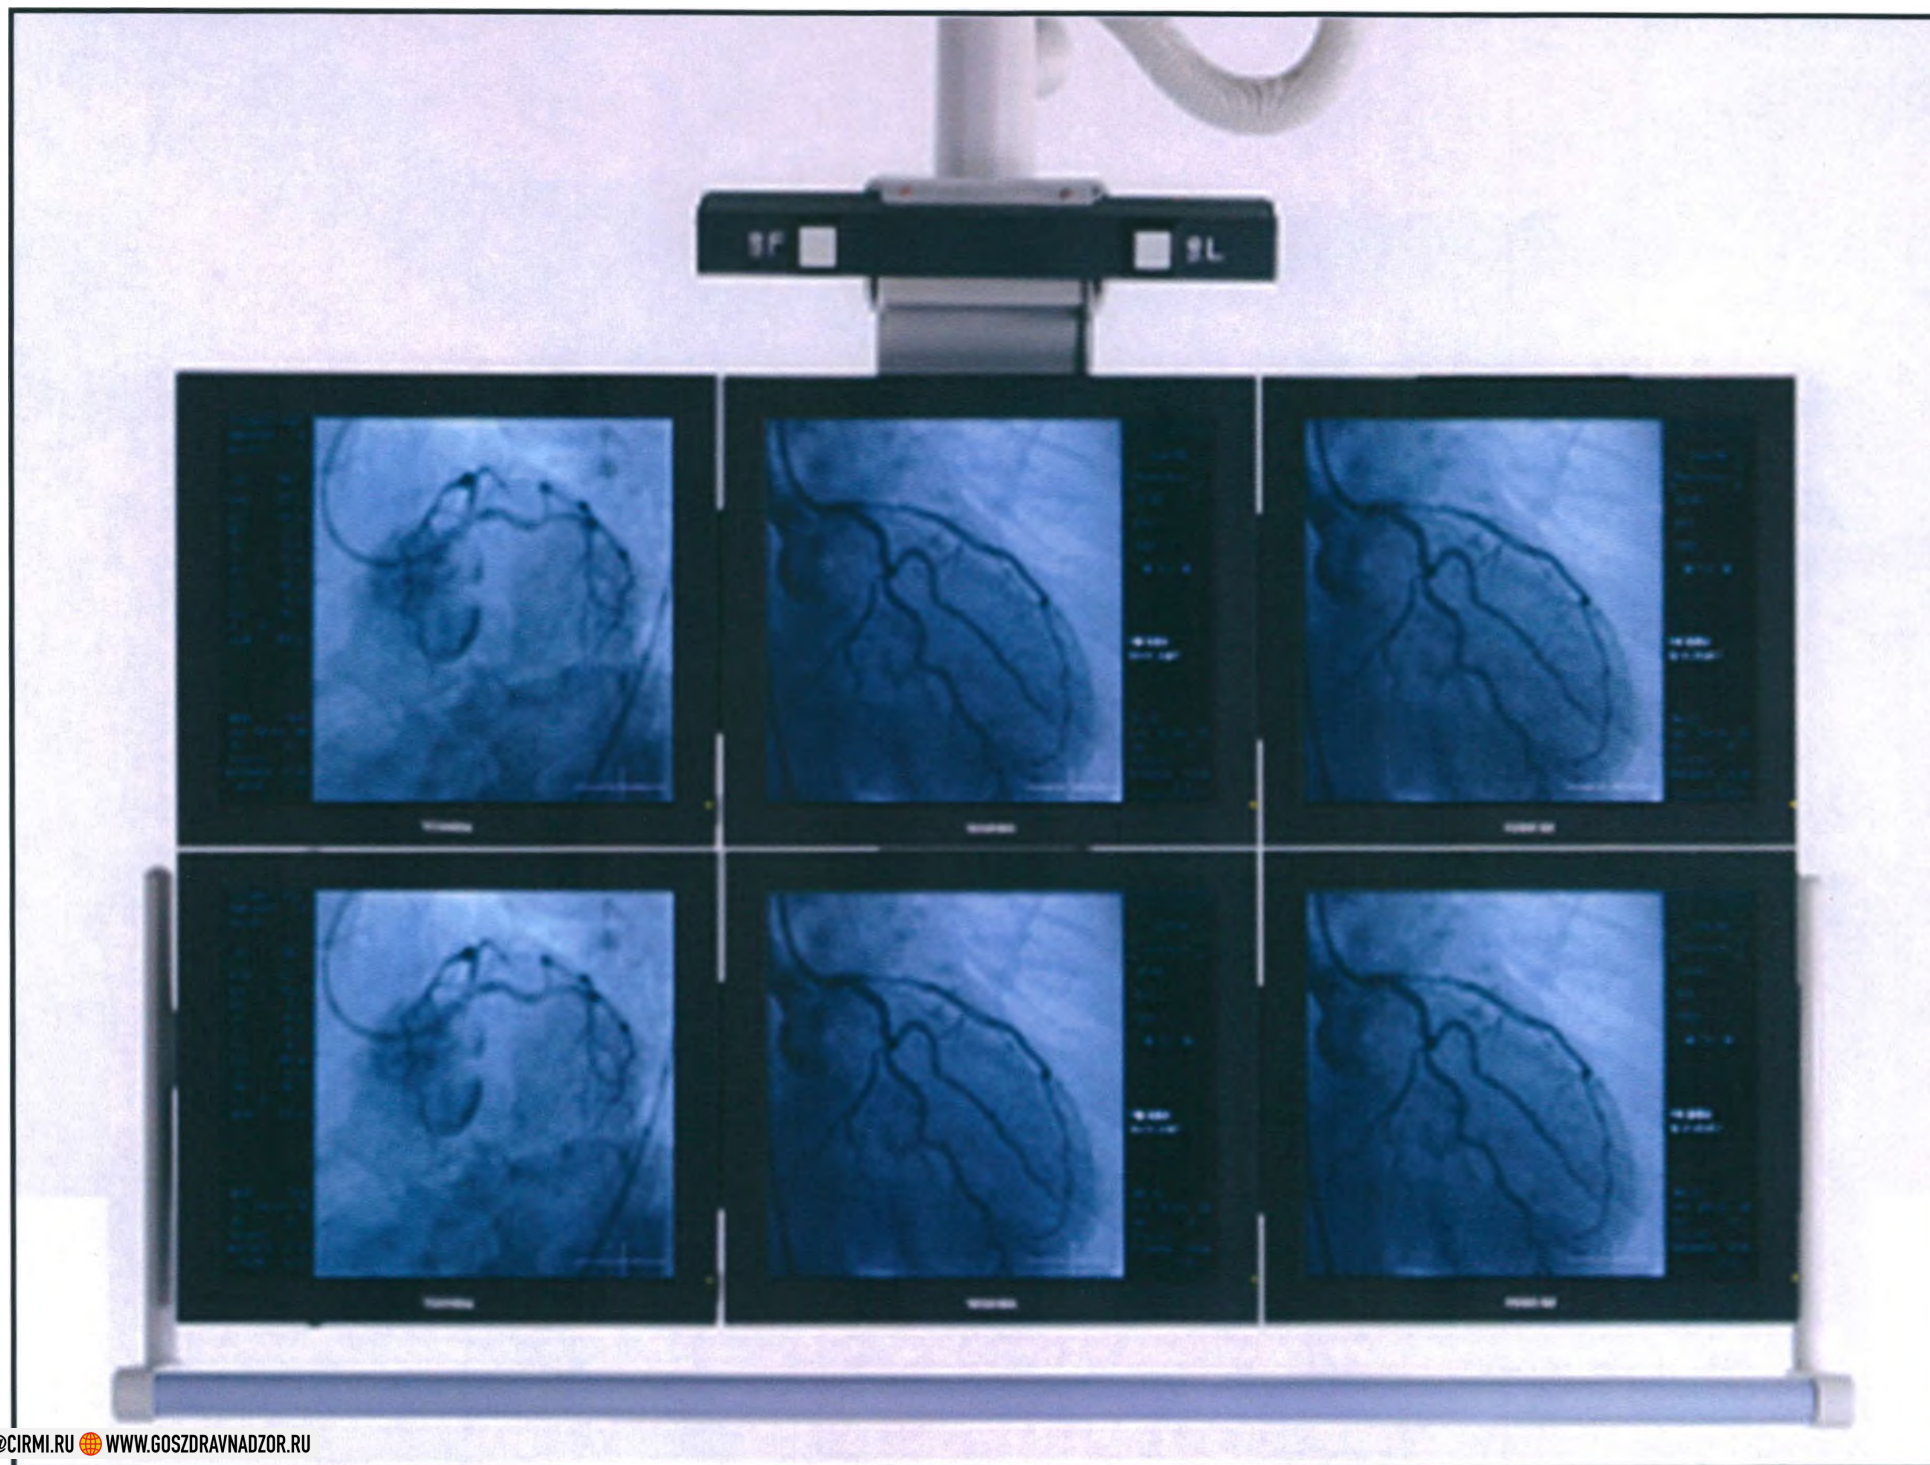


21. Подвесное устройство для мониторов.


300

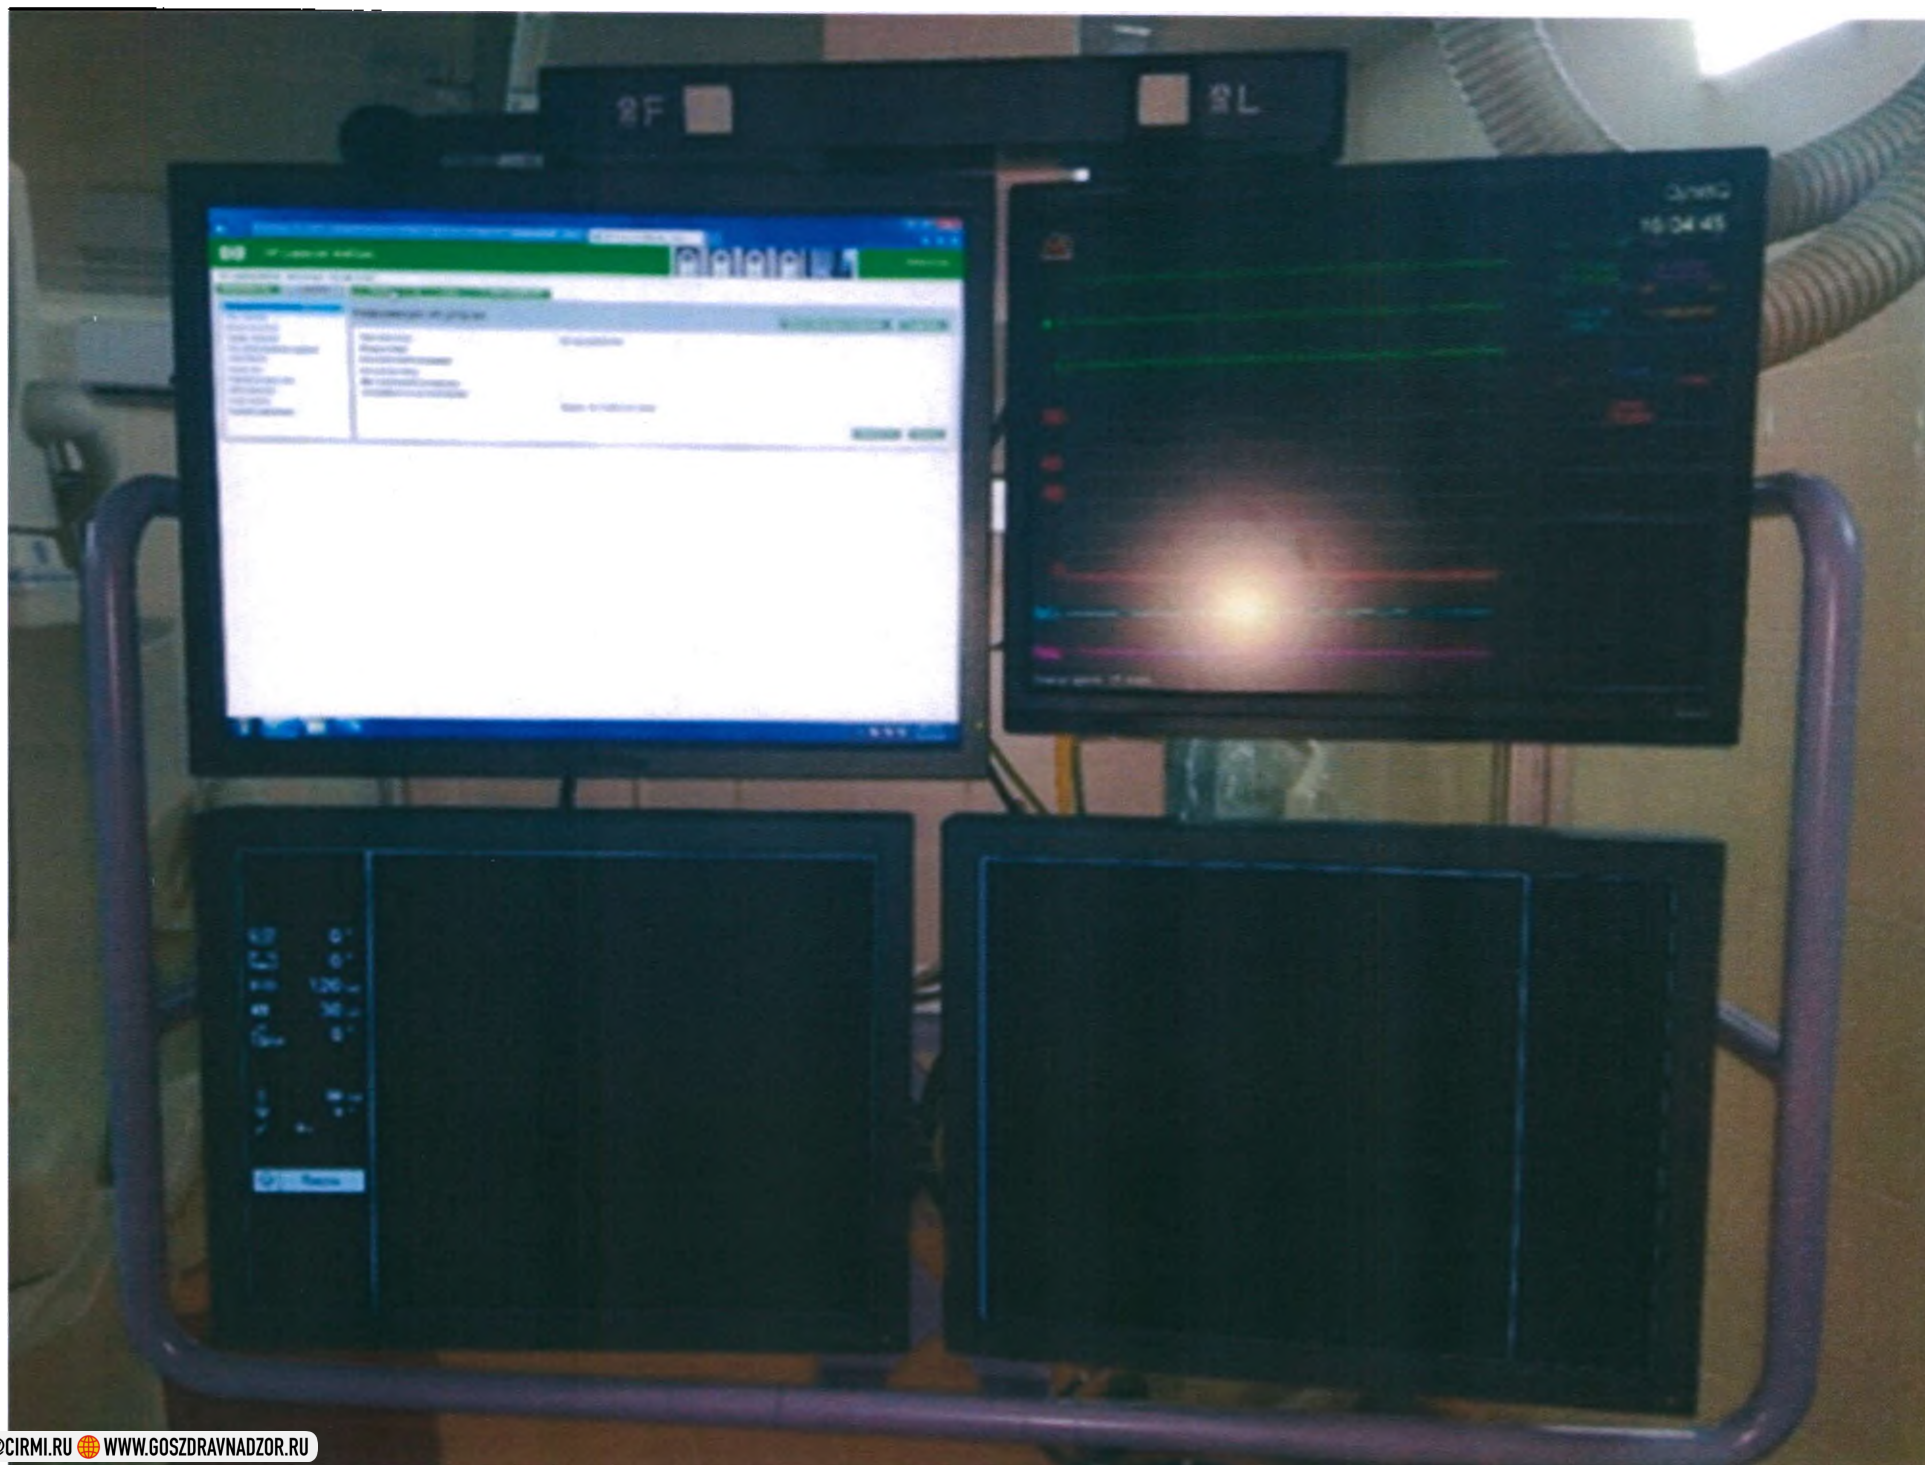

21. Подвесное устройство для мониторов.


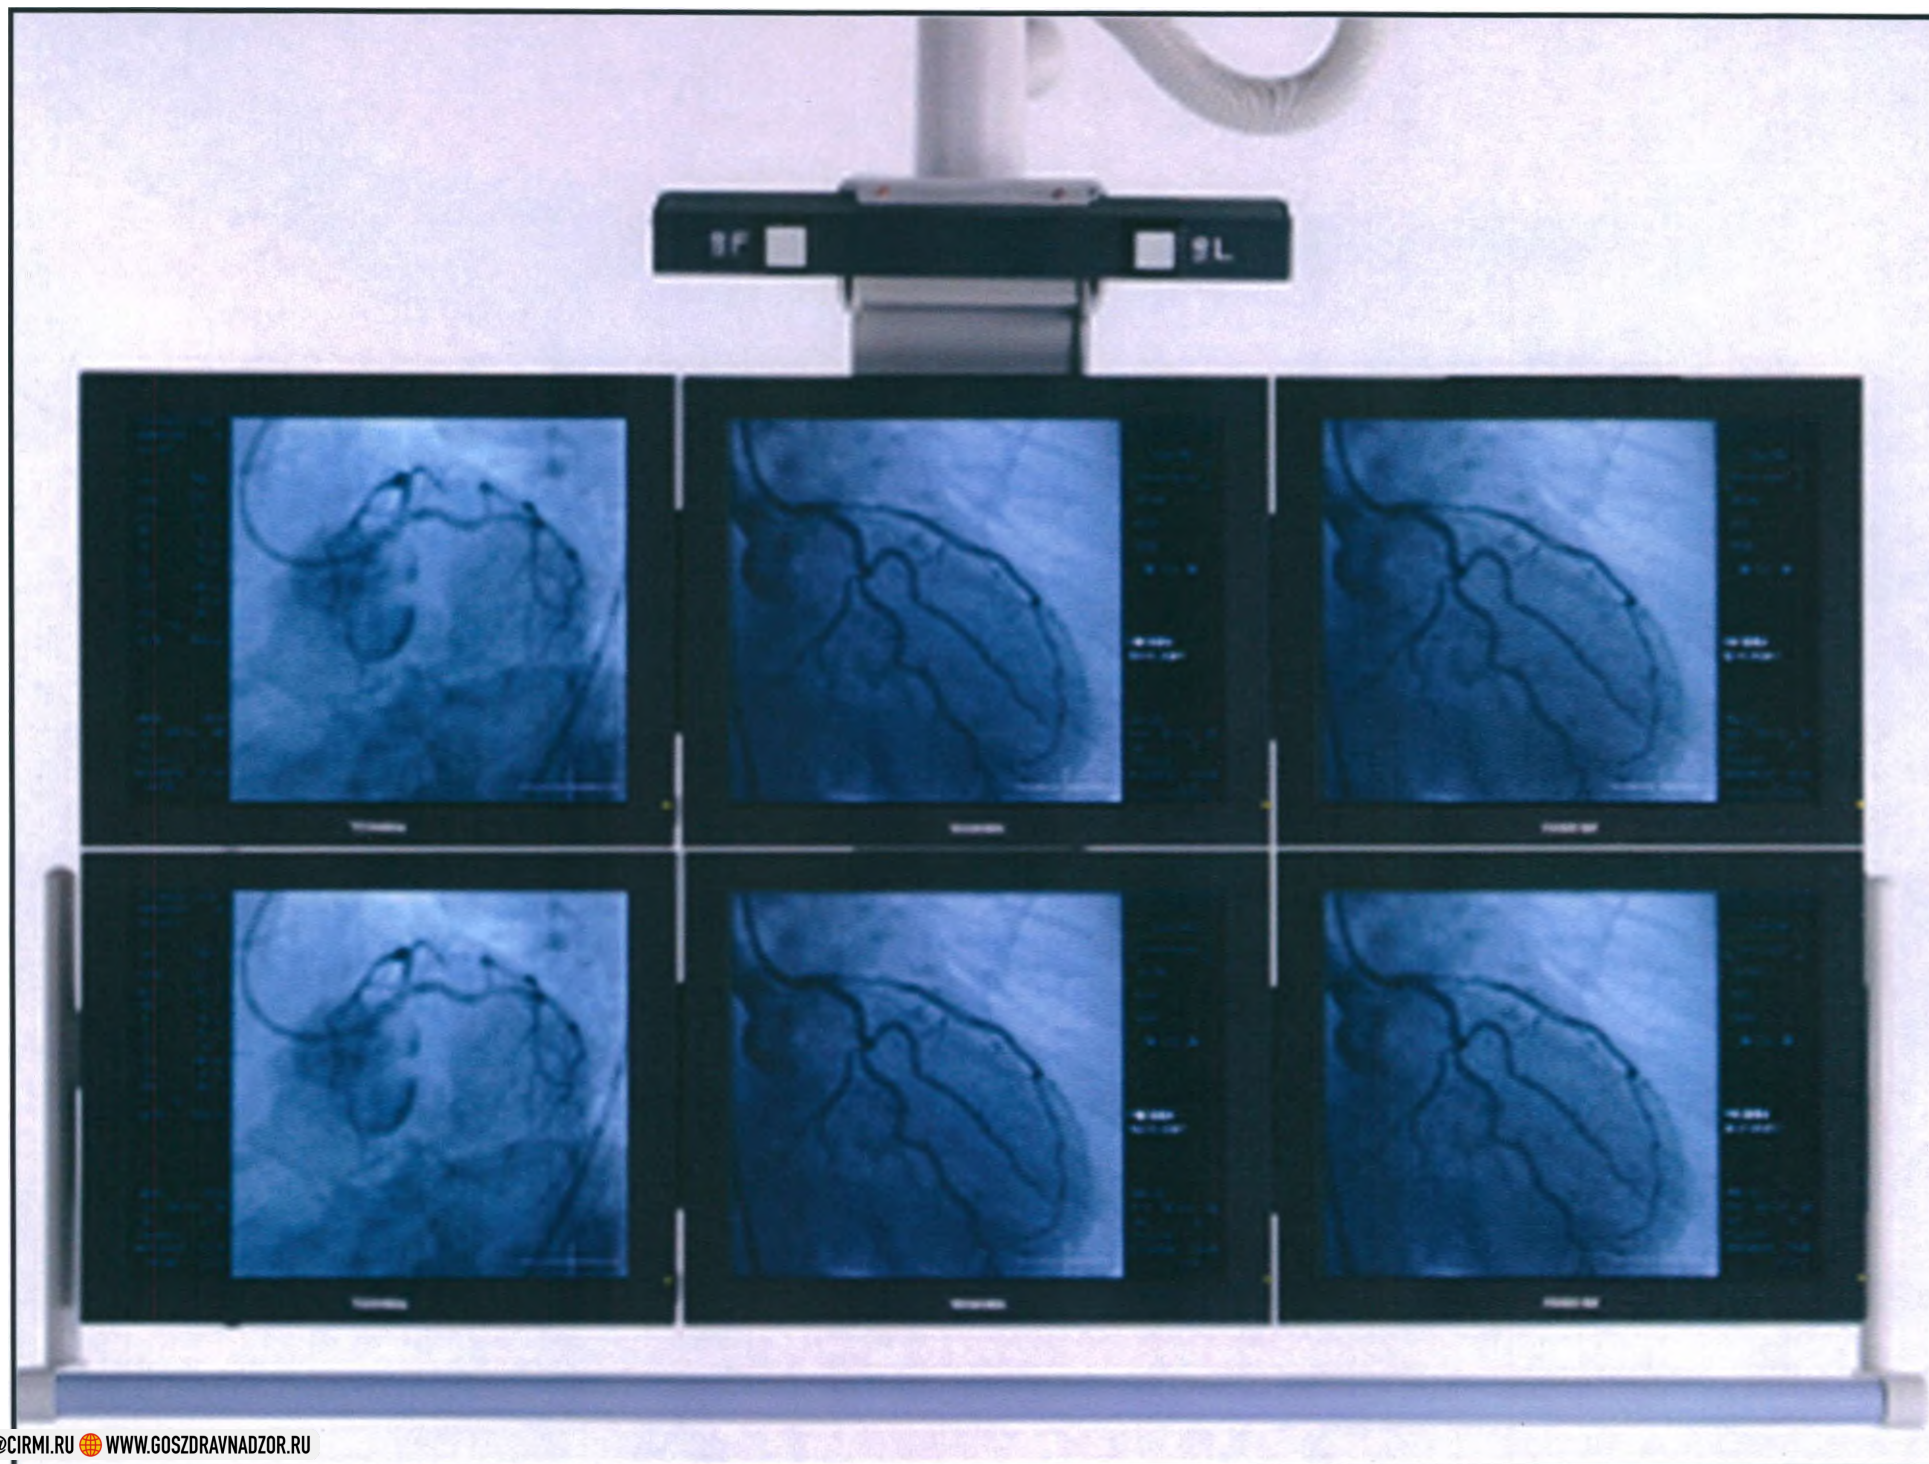


21. Подвесное устройство для мониторов.

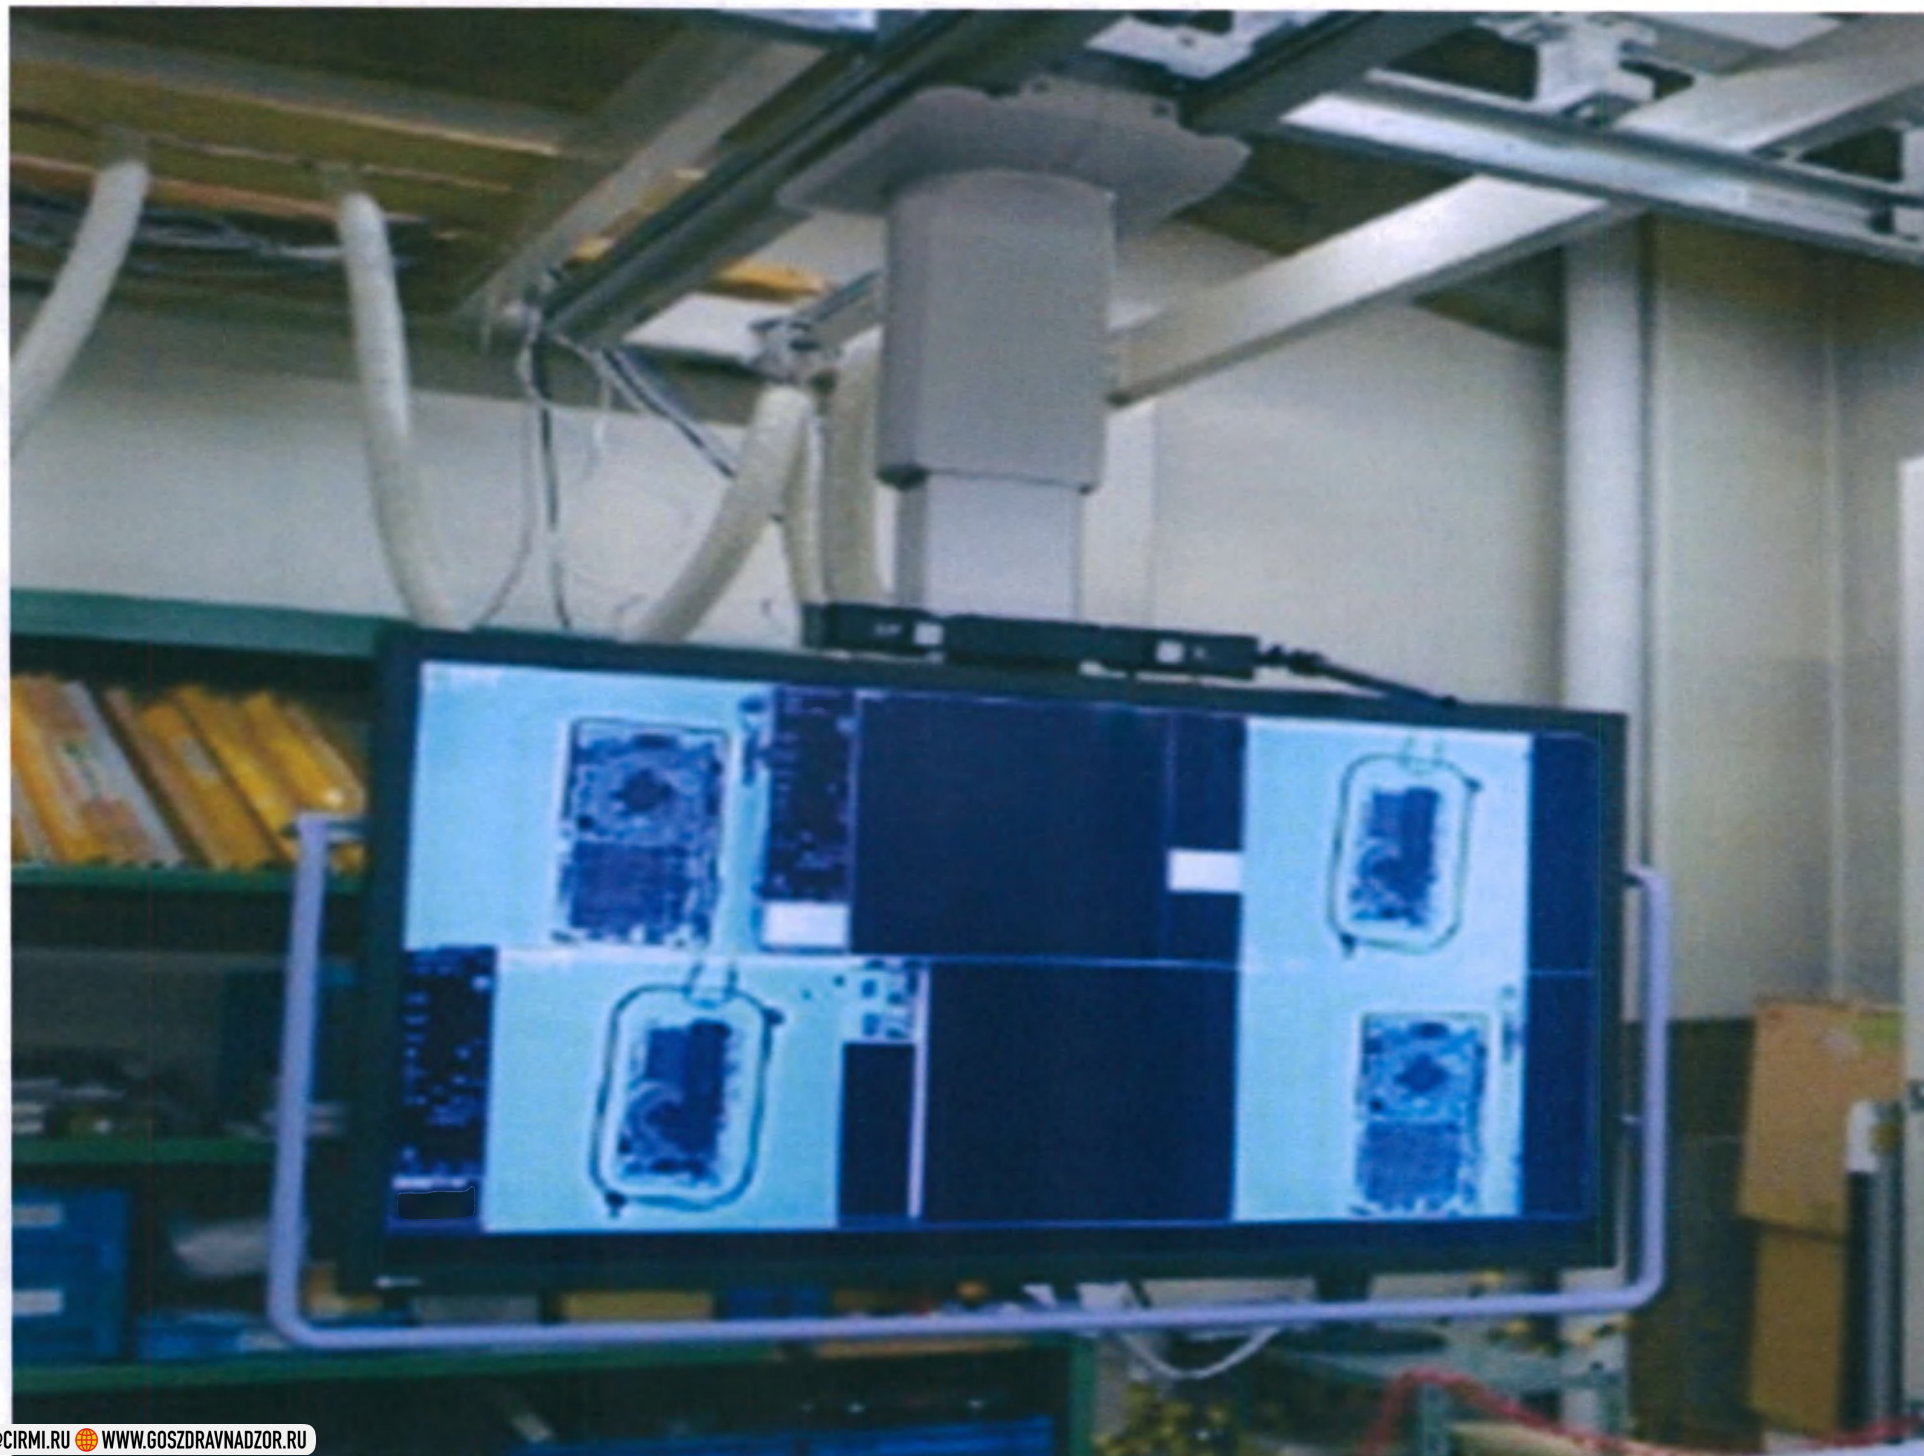



22. Комплект двухпроекционной системы.

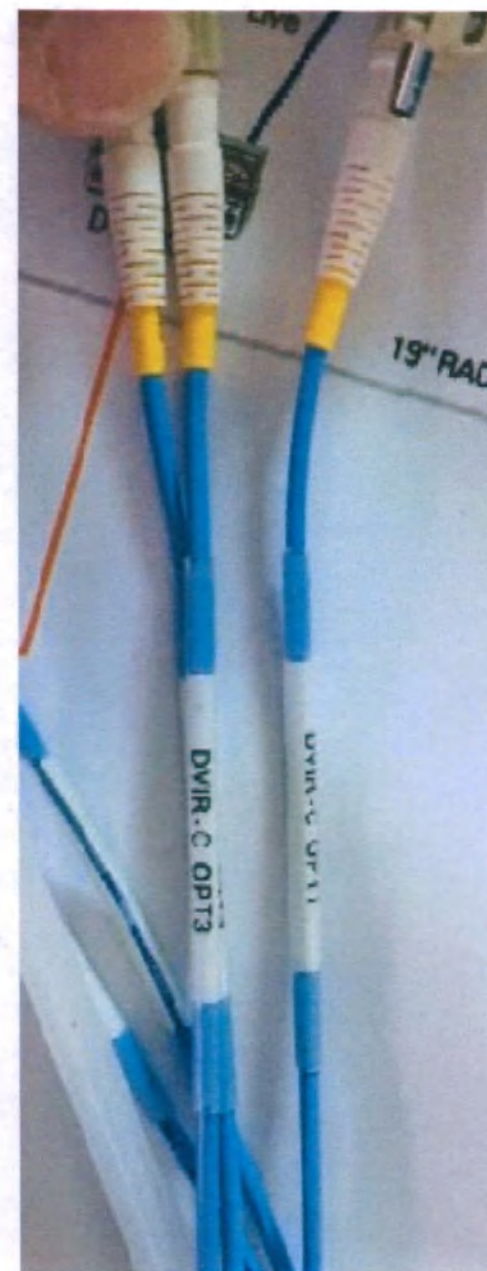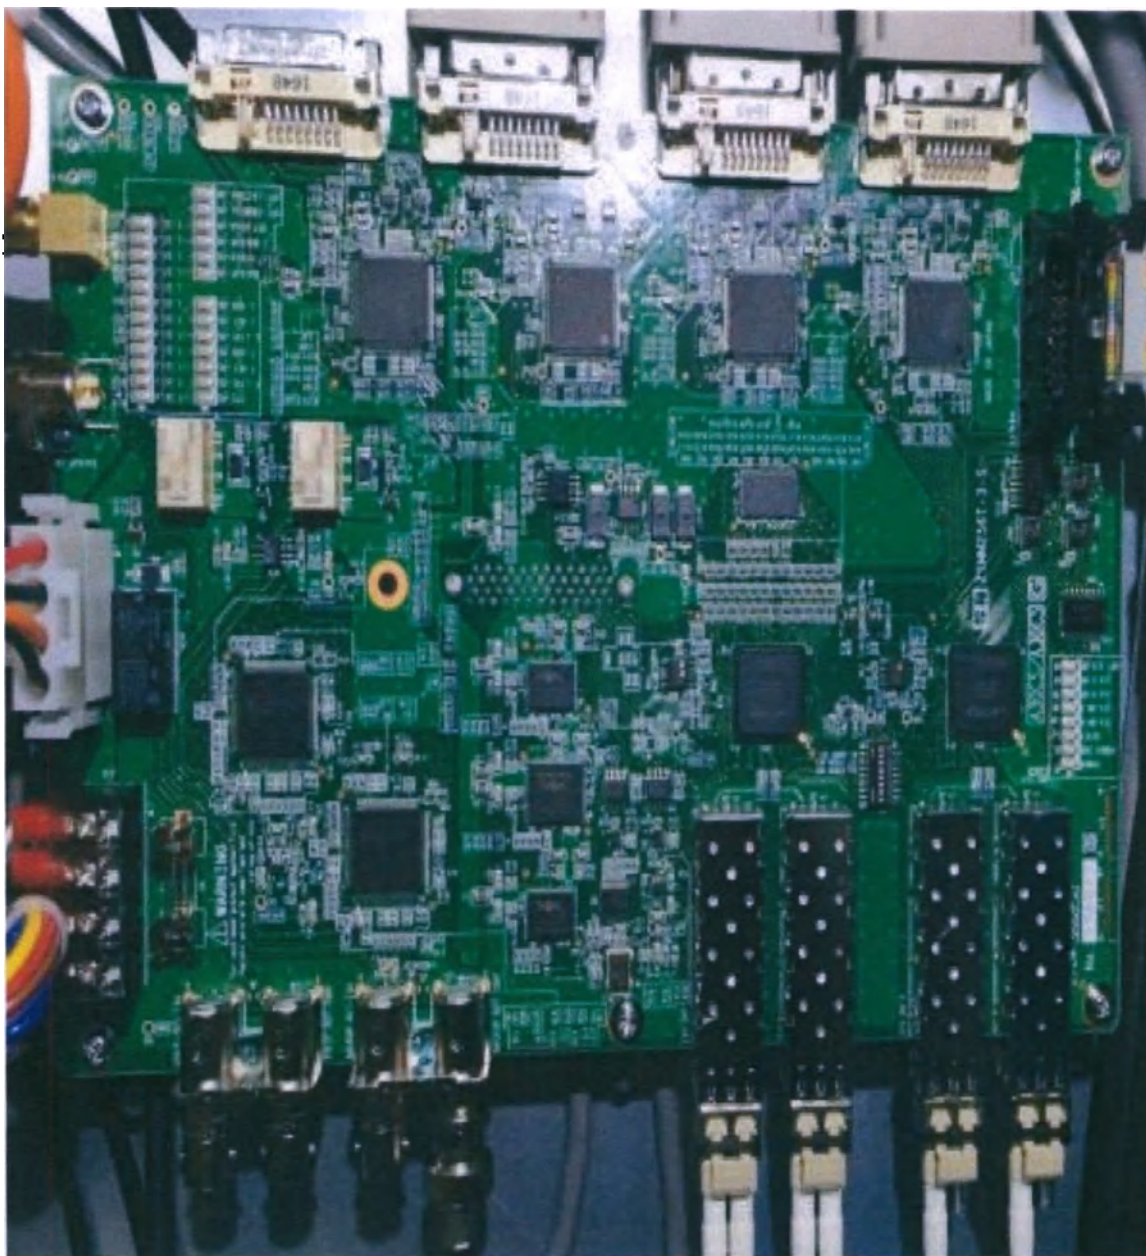



Микрофон в кабинете управления (talk microphone)



Усилитель звуковых сигналов в кабинете управления (talk amp)





Микрофон в кабинете сканирования (listen mic)




Усилитель звуковых сигналов в кабинете сканирования (listen amp)

24. Ионизационная камера дозиметра (производитель PTW-Freiburg, Германия).

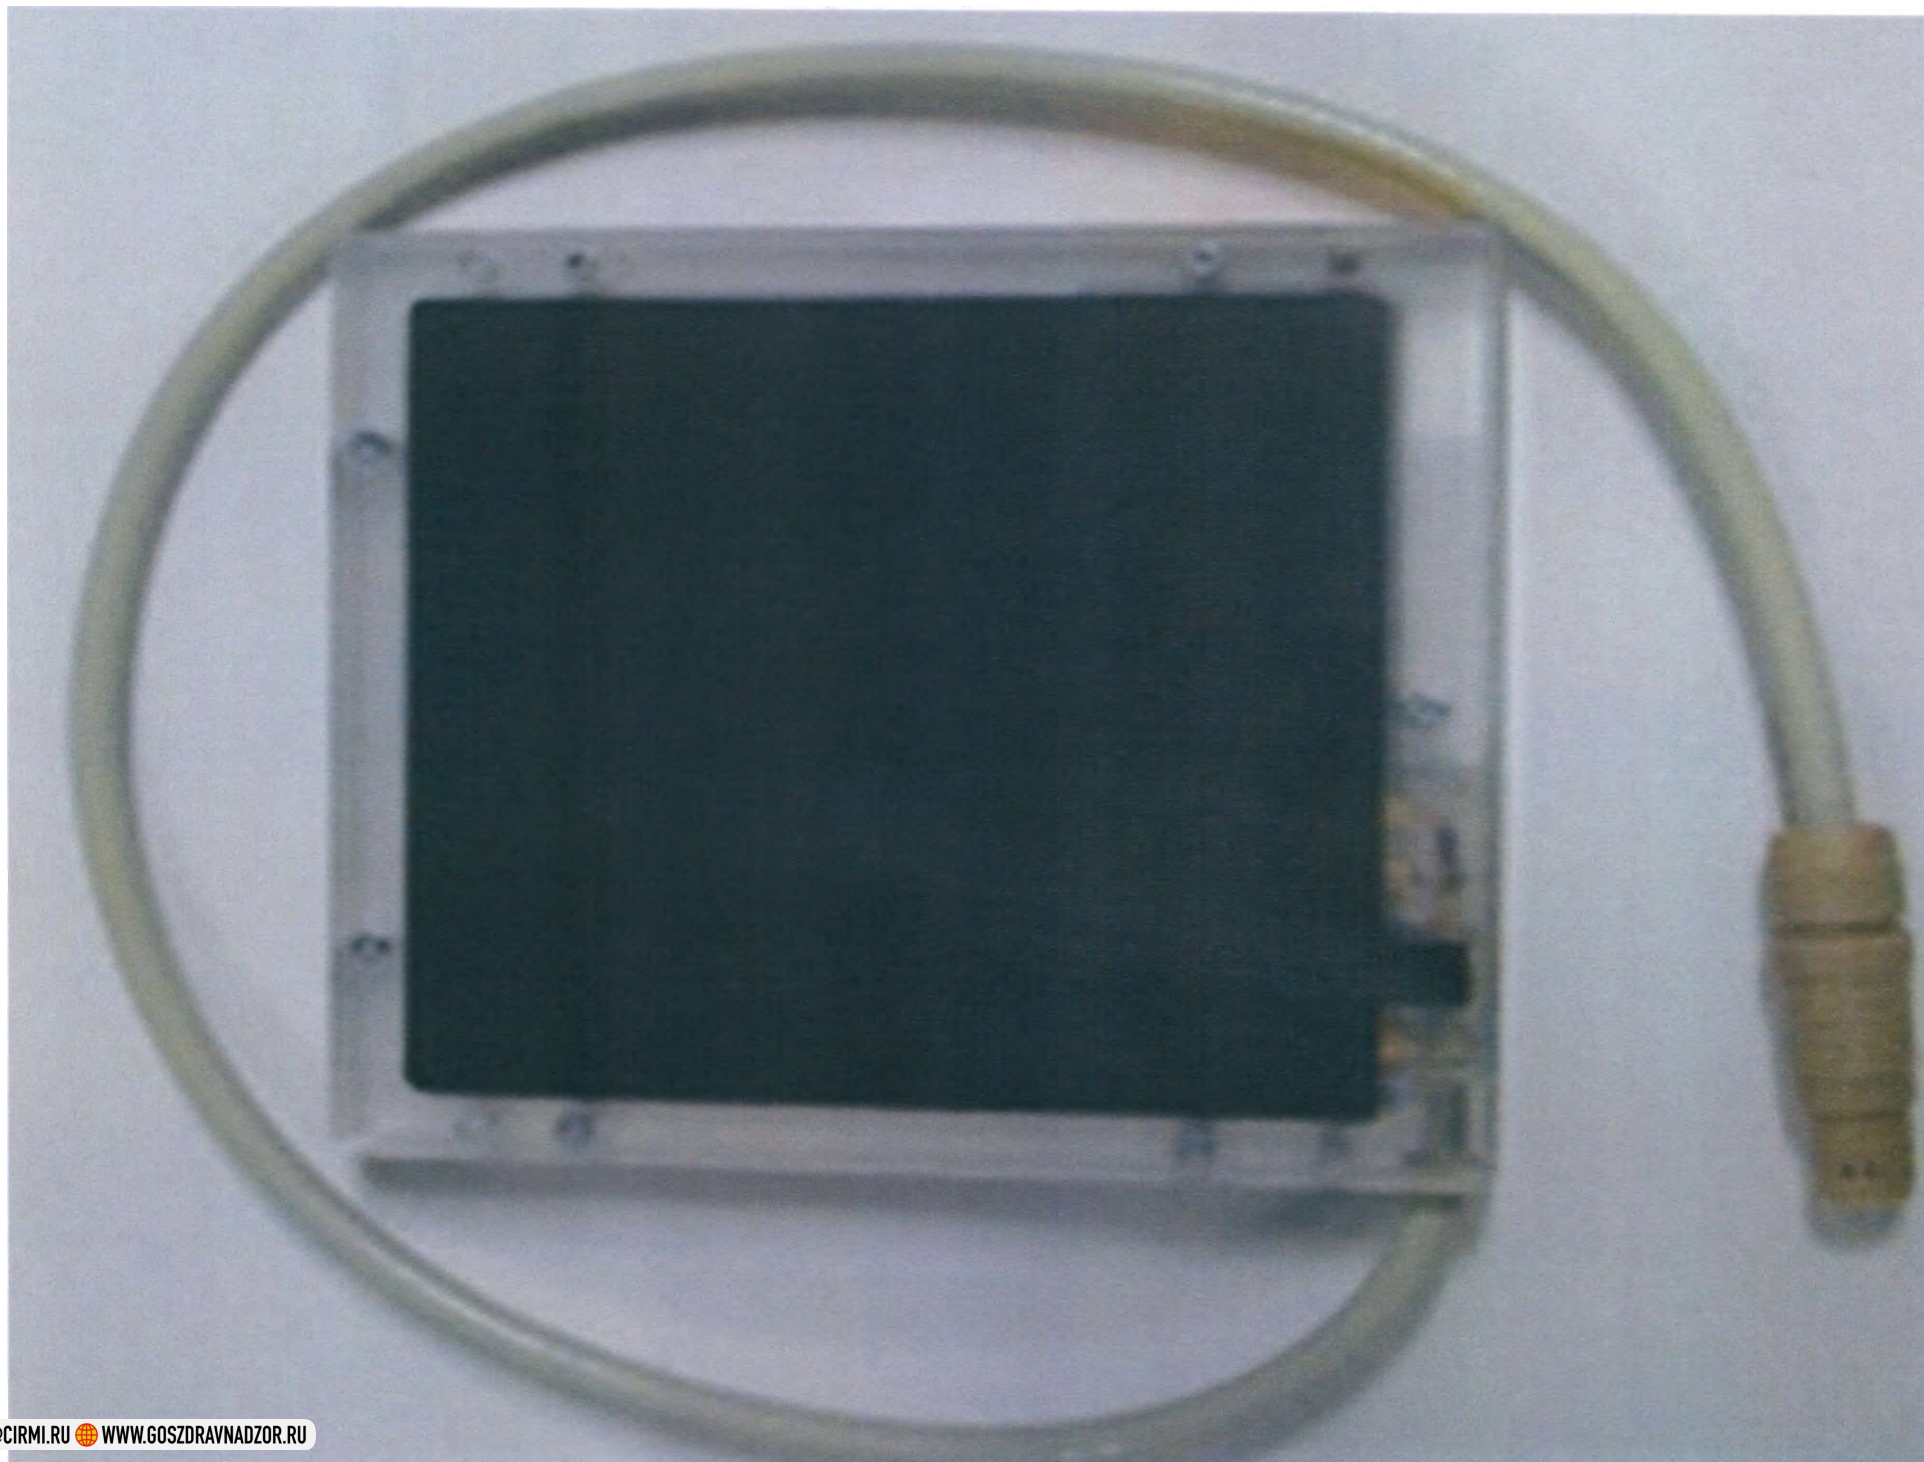


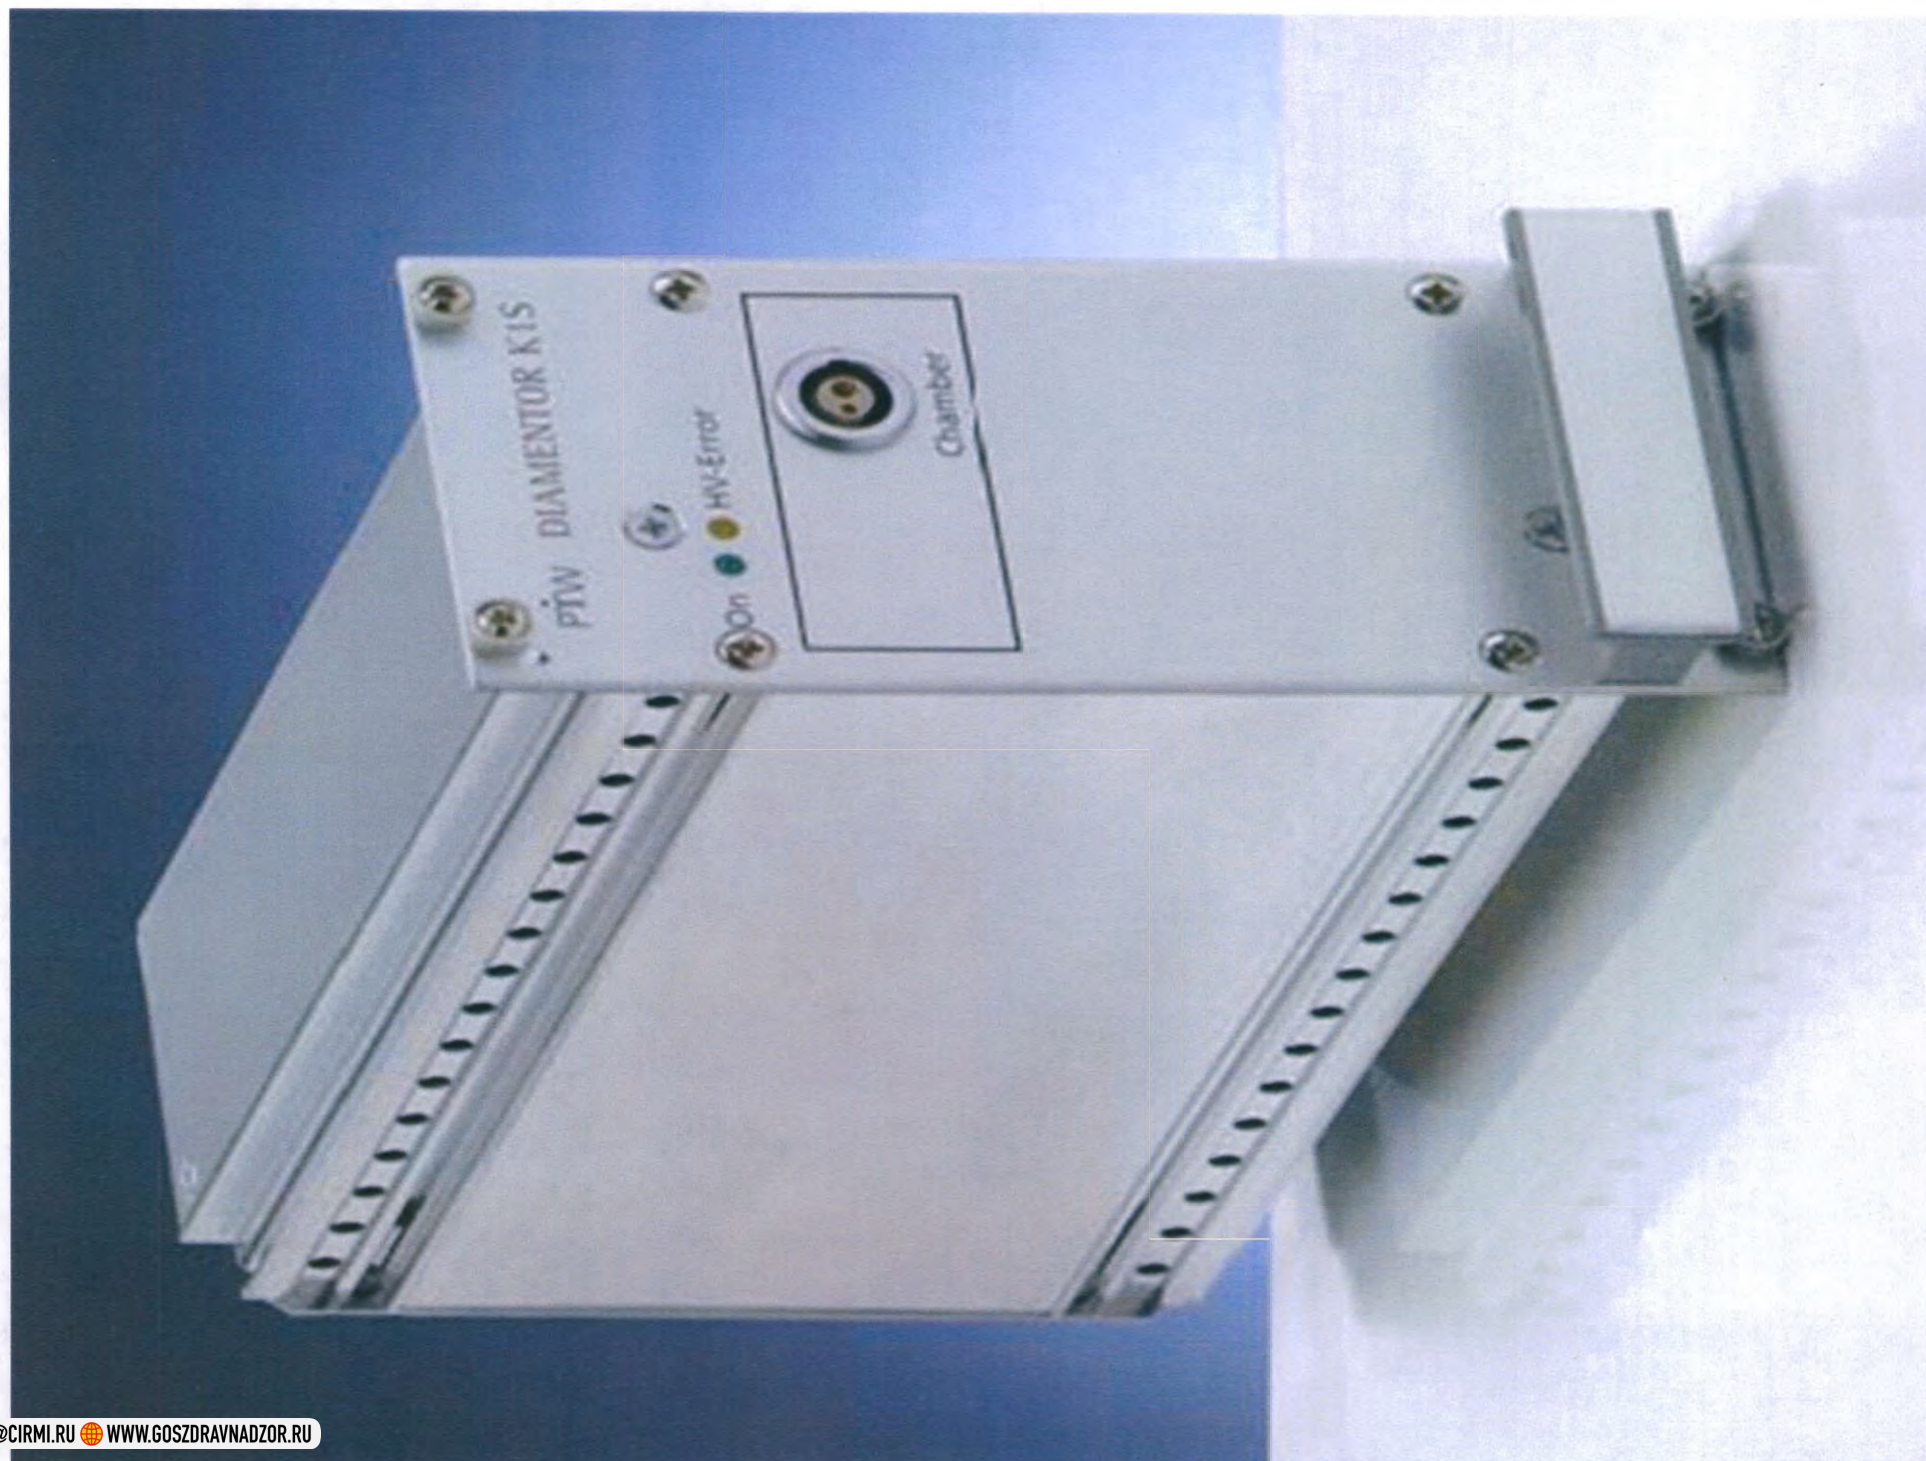


26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - усилитель – 1 шт.

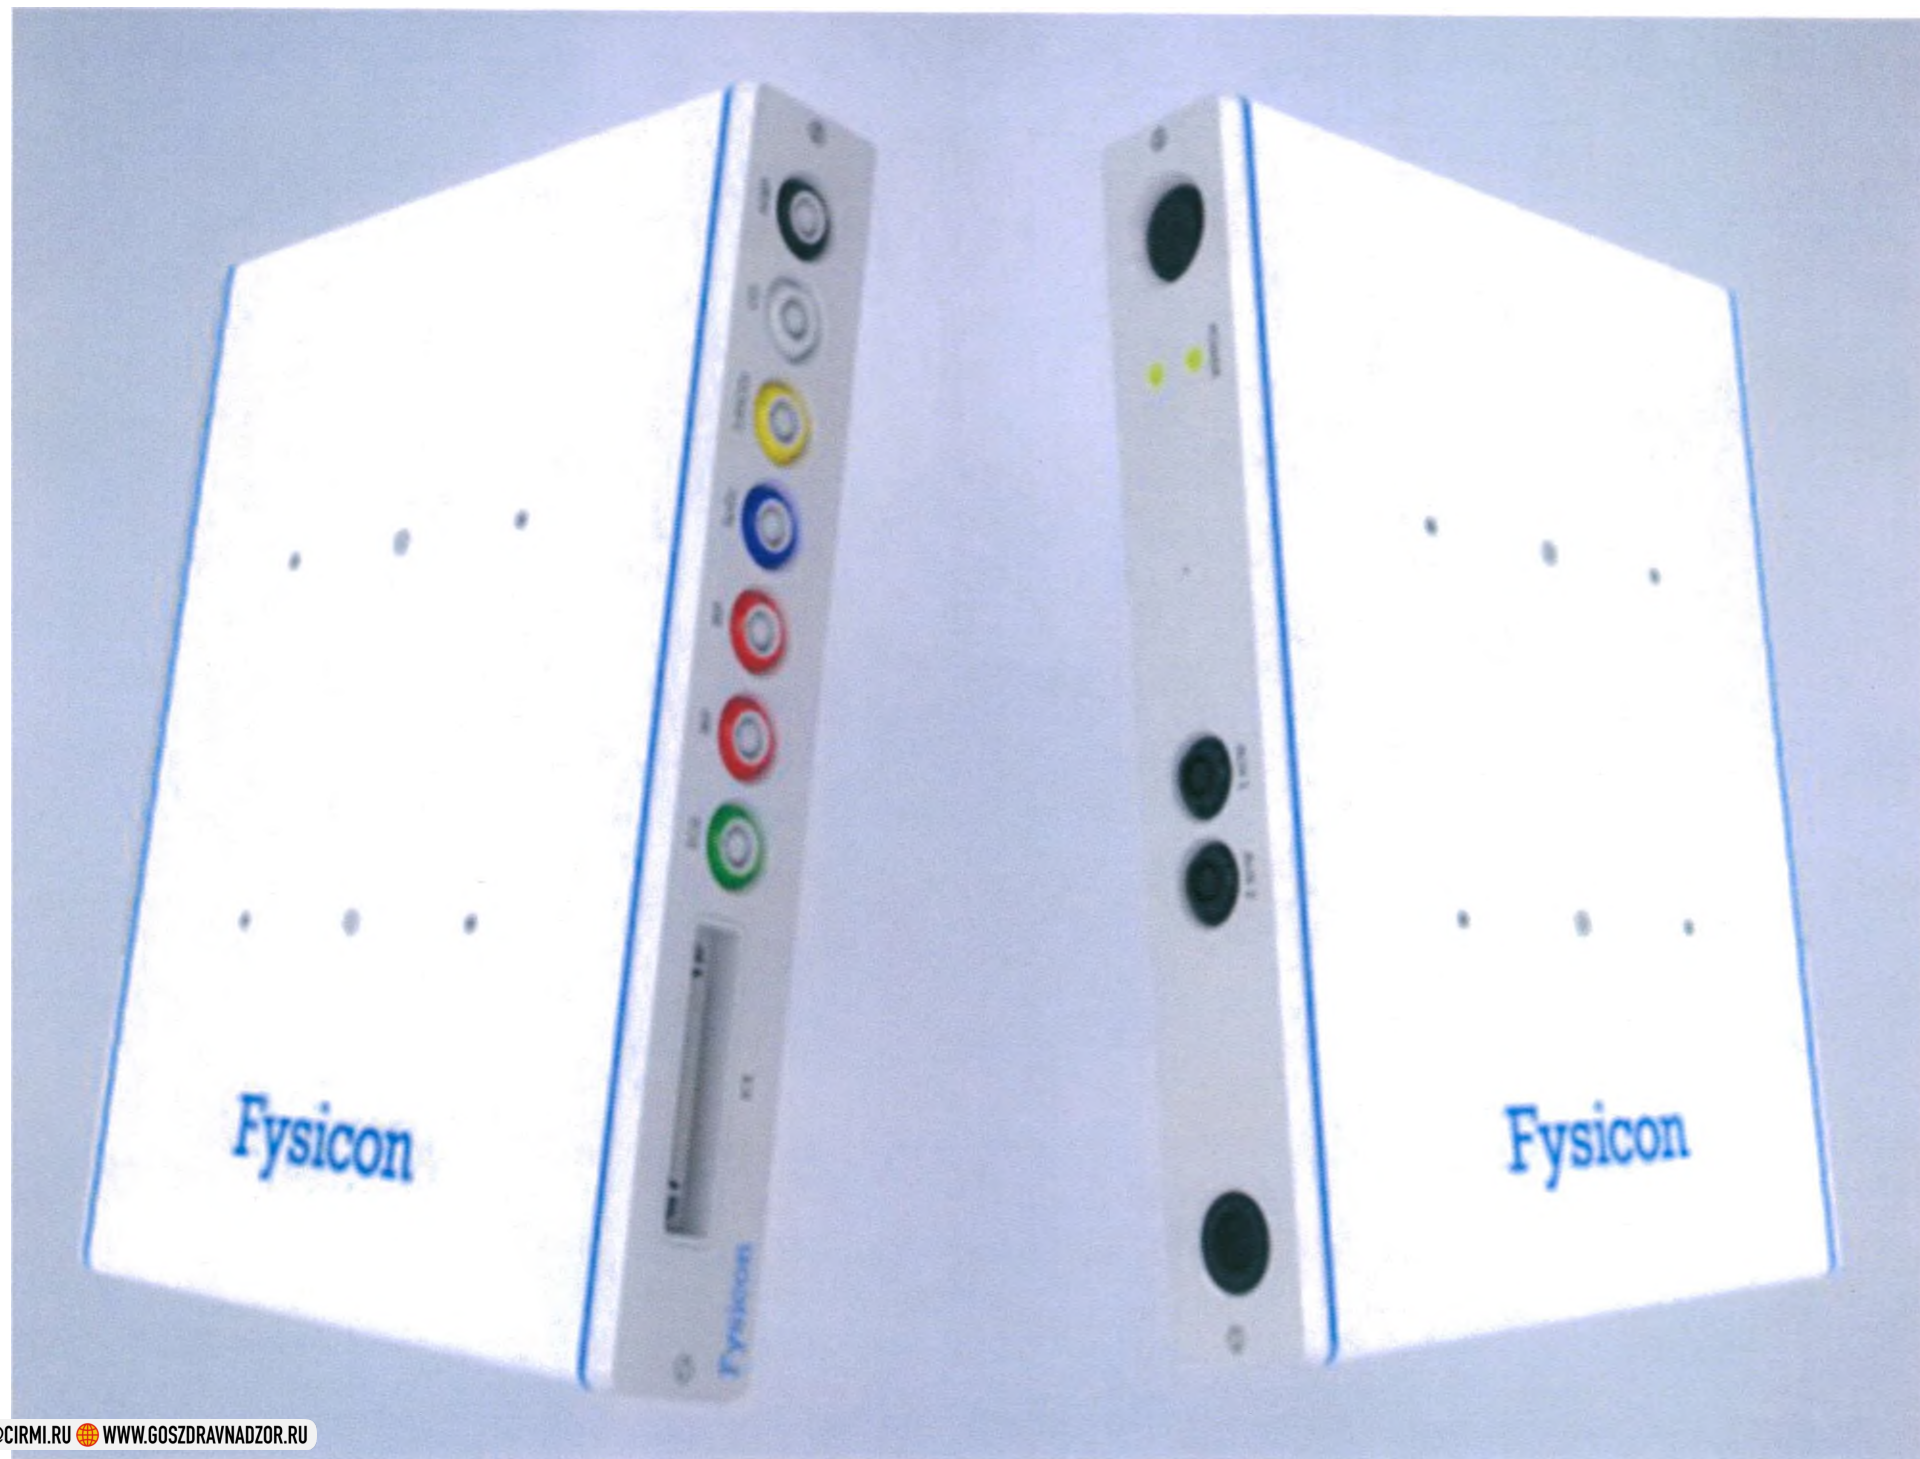


26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - крепеж для DIN-рейки - 1 шт.;

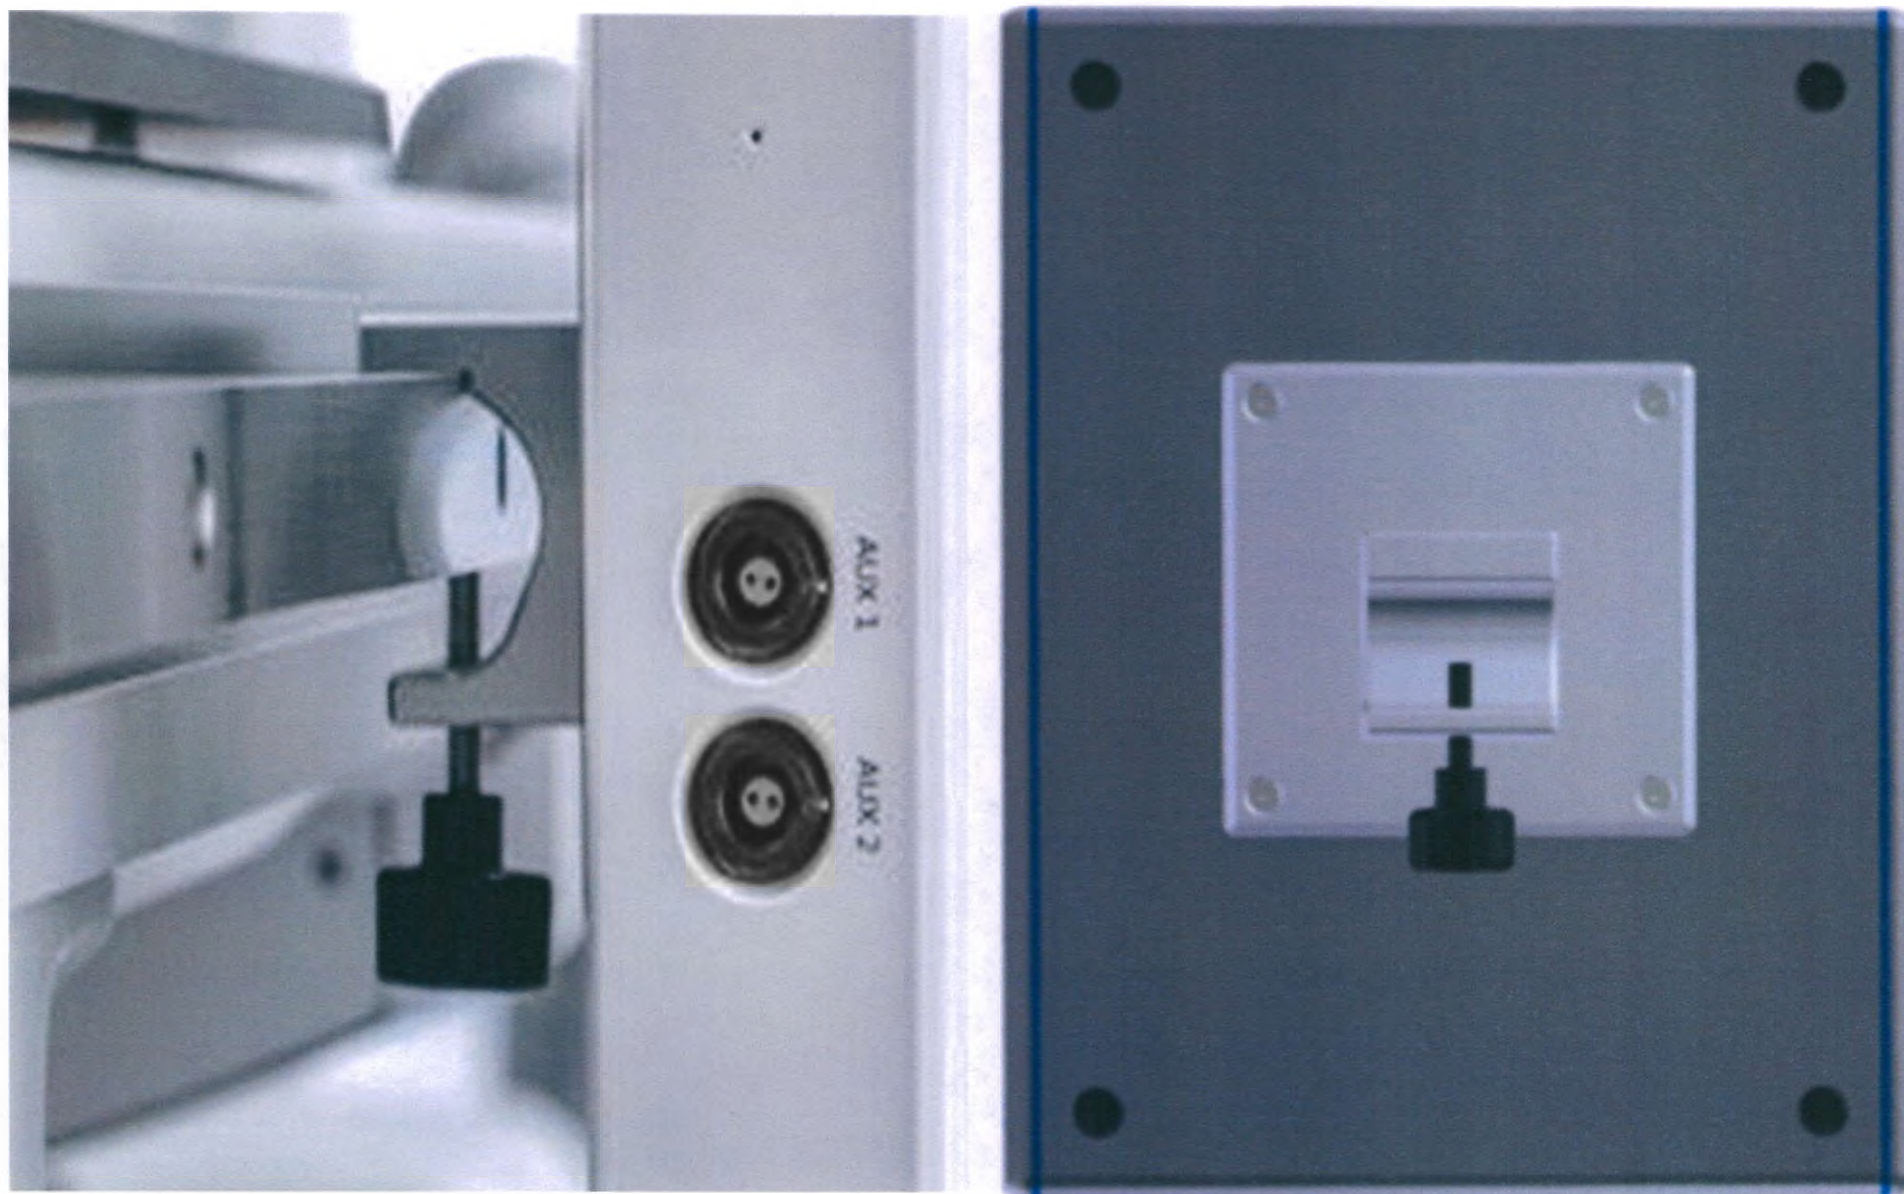

26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - процессор отчетов – 1 шт.; - процессор для работы в реальном времени (при необходимости), 1 шт.;

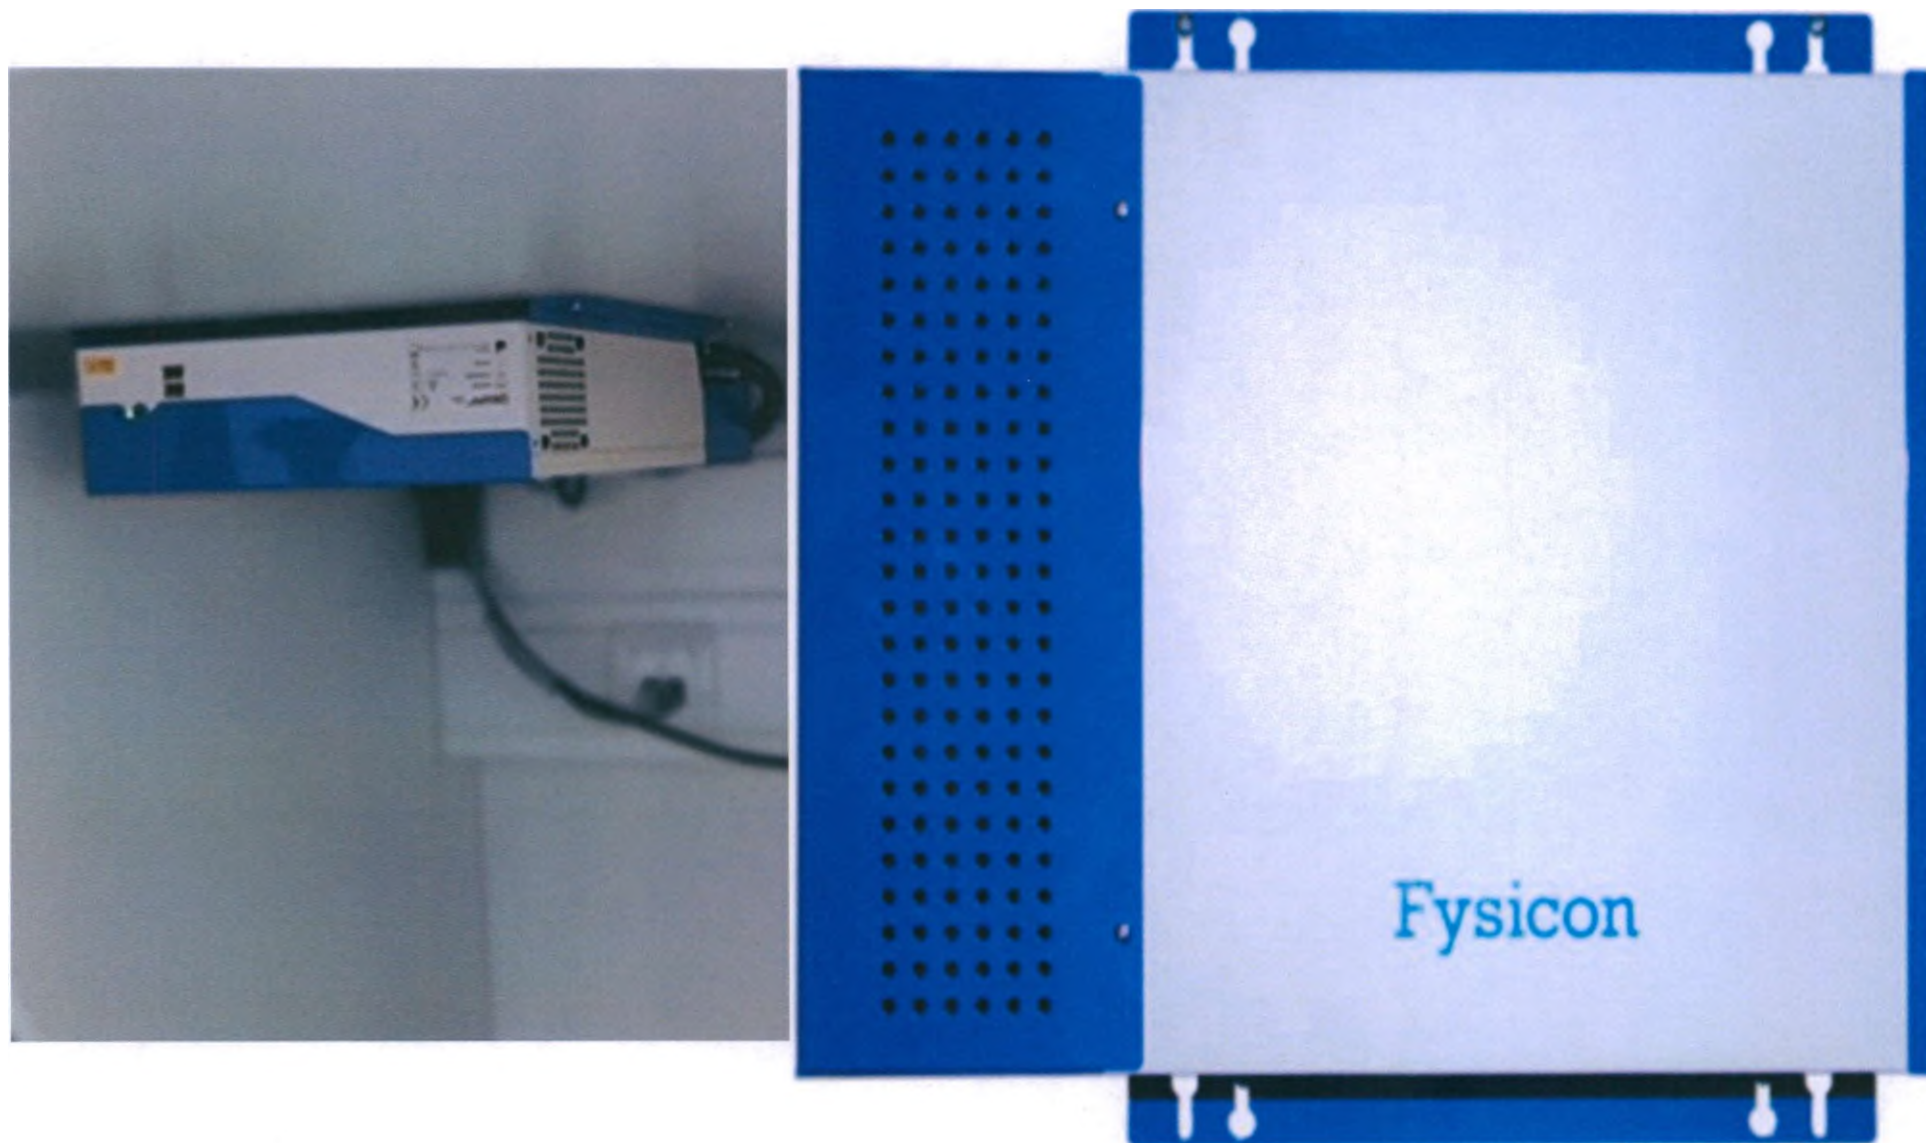

26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - кабель системы, не более 3 шт.

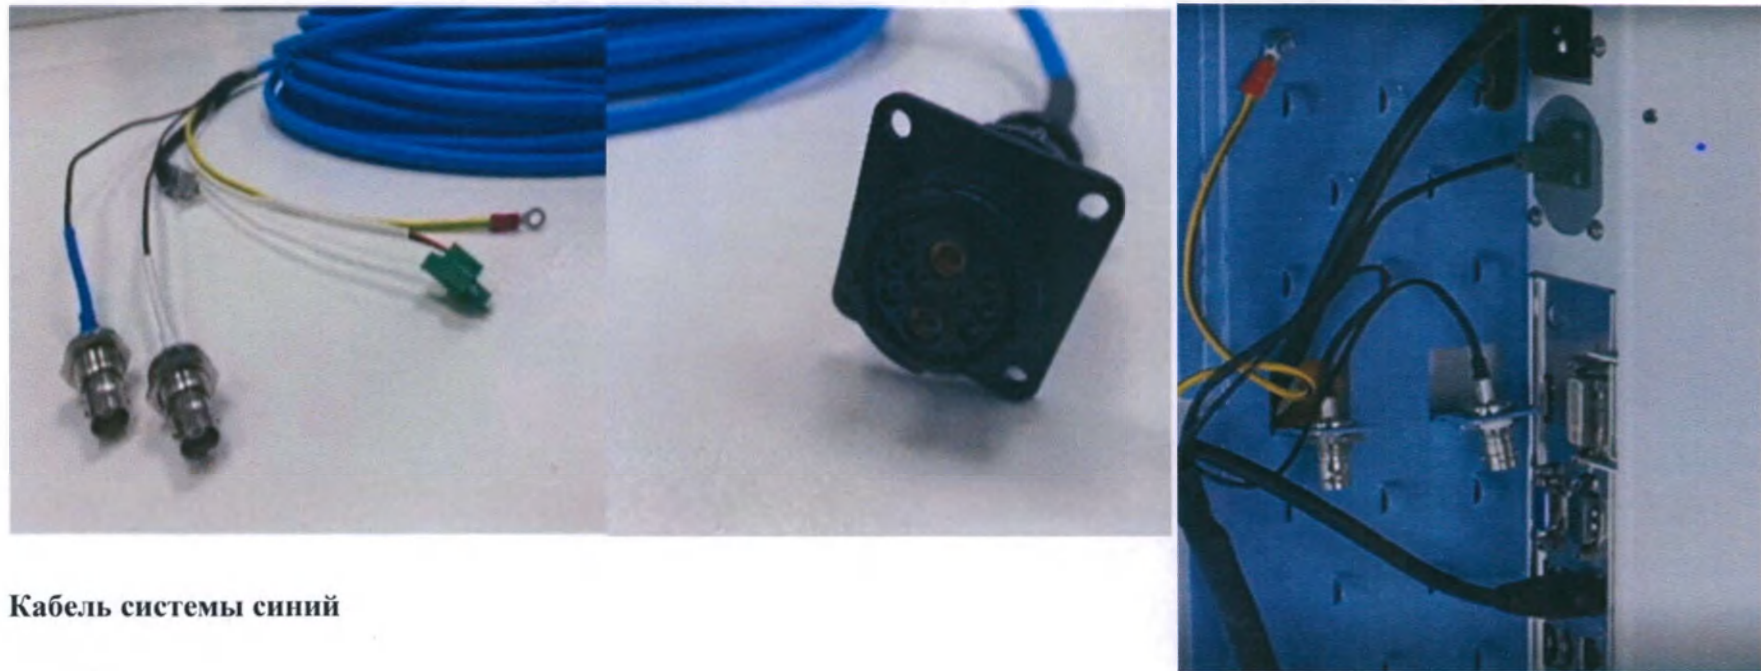

Кабель системы синий




Кабель системы белый

Кабель информационный зеленый

26. Система мониторинга физиологических параметров QMAPP (при необходимости), в составе: - адаптер питания, не более 3 шт.





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Alphenix

**МОДЕЛЬ INFX-8000V/B, INFX-8000V/Y,
INFX-8000V/P**

ВАЖНО!

Перед эксплуатацией оборудования ознакомьтесь
с настоящим руководством. После прочтения
держите руководство в легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2018–2020

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Принадлежности: 1. Вспомогательная консоль для двухпроекционной системы





1. Вспомогательная консоль для двухпроекционной системы (Подставка)



2. Боковая консоль стола (для использования в сочетании с планшетной консолью) для двухпроекционной системы.



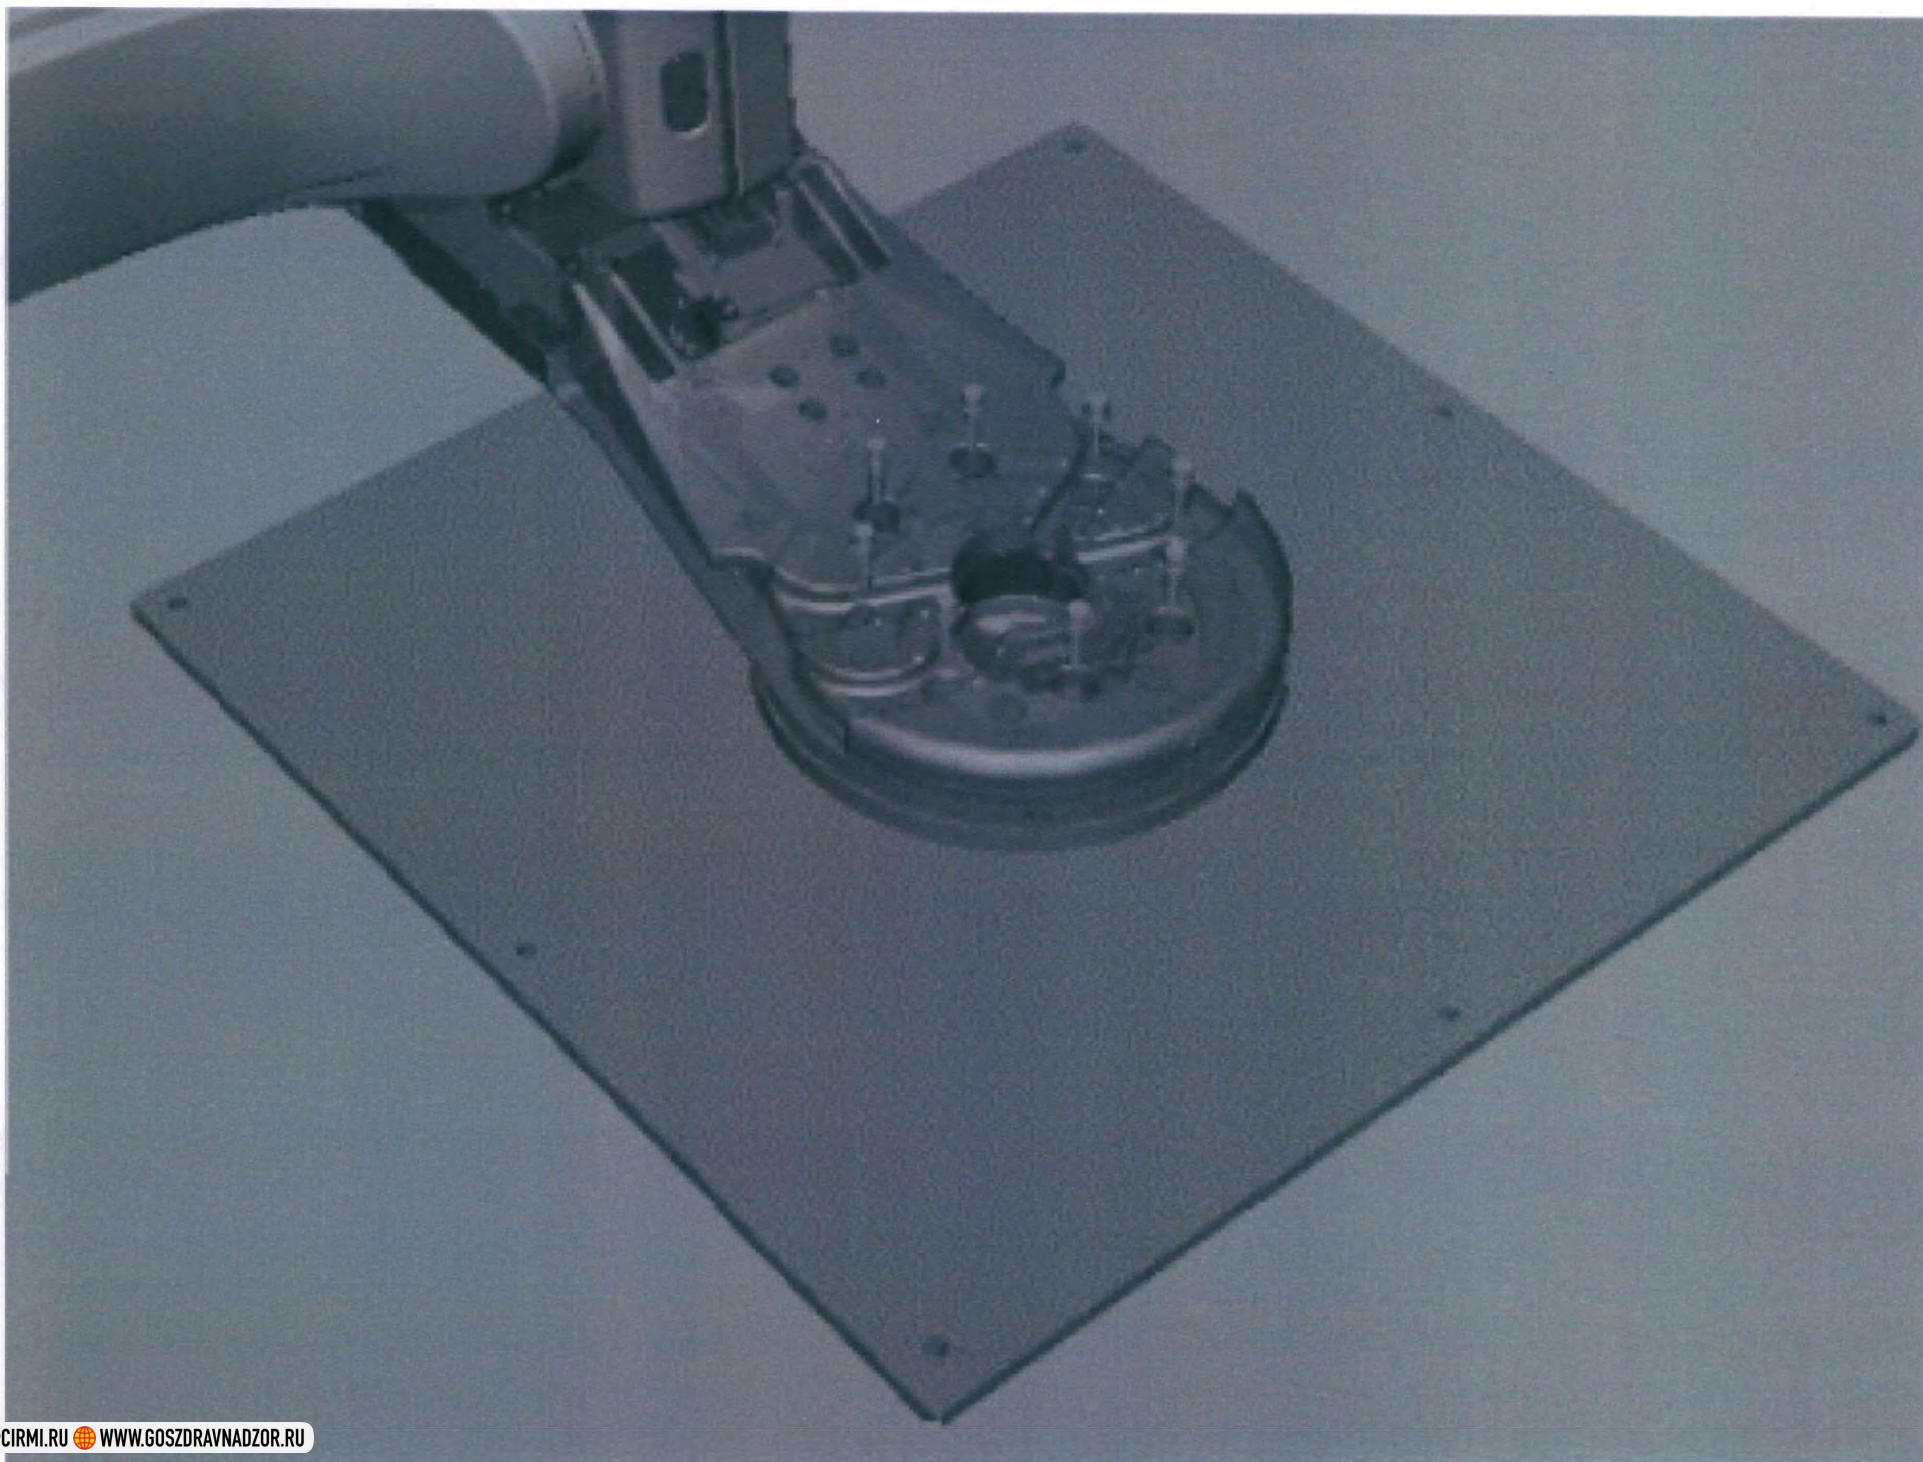

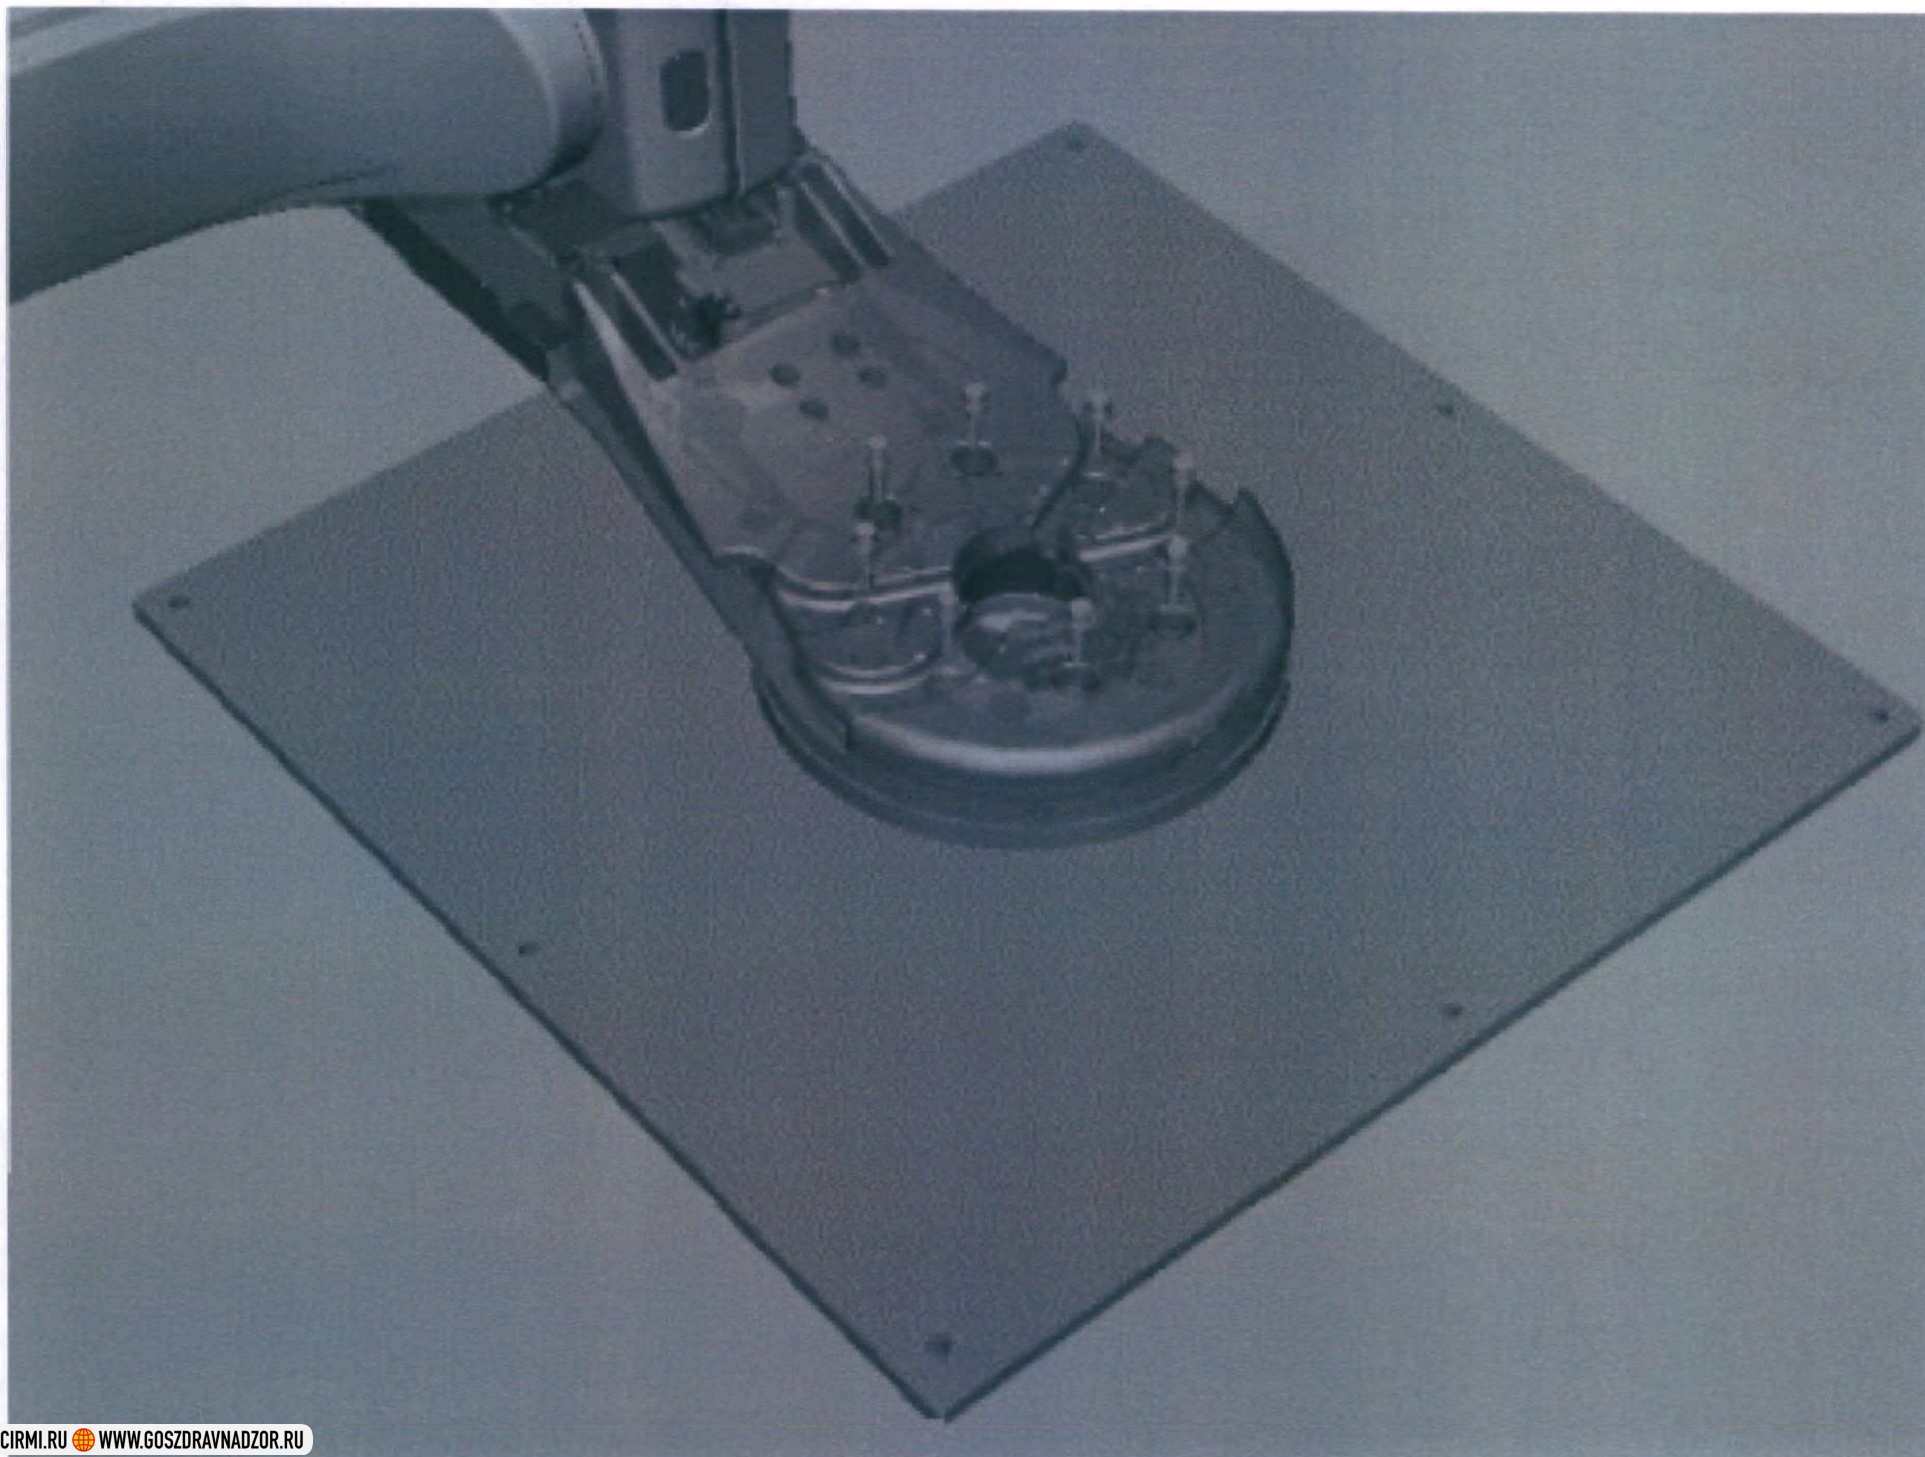

5. Ножной переключатель (дополнительный) для двухпроекционной системы.

329




6. Беспроводной ножной переключатель для двухпроекционной системы.



Беспроводной ножной переключатель




Сетевой адаптер

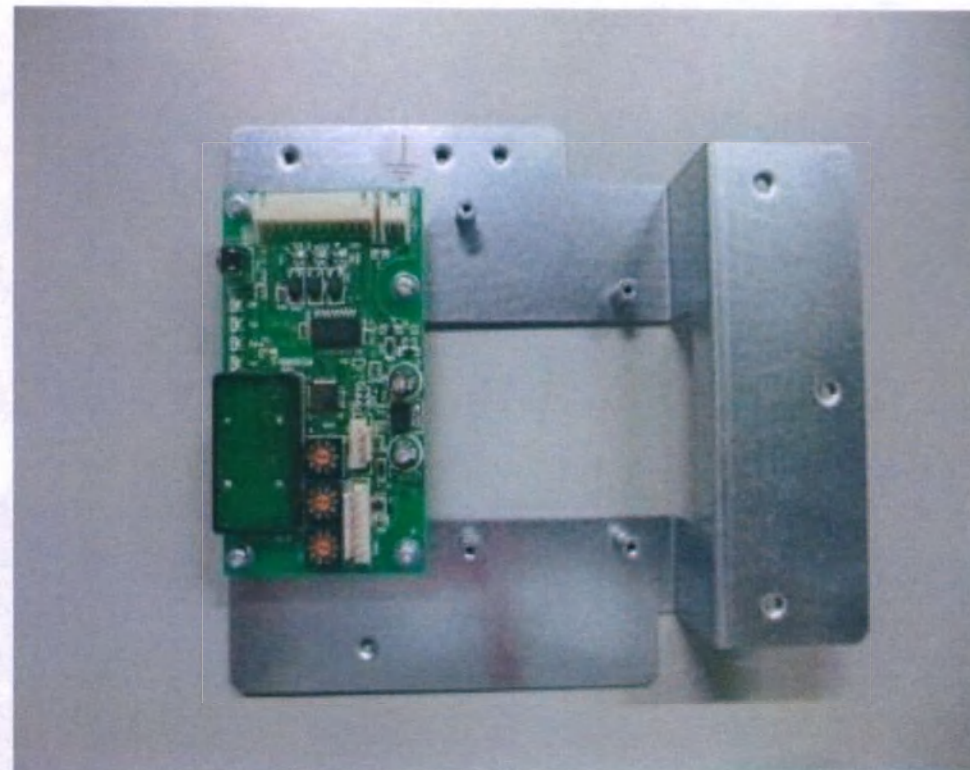



Приемник сигнала

7. Комплект беспроводного ножного переключателя (для CAT-850B).

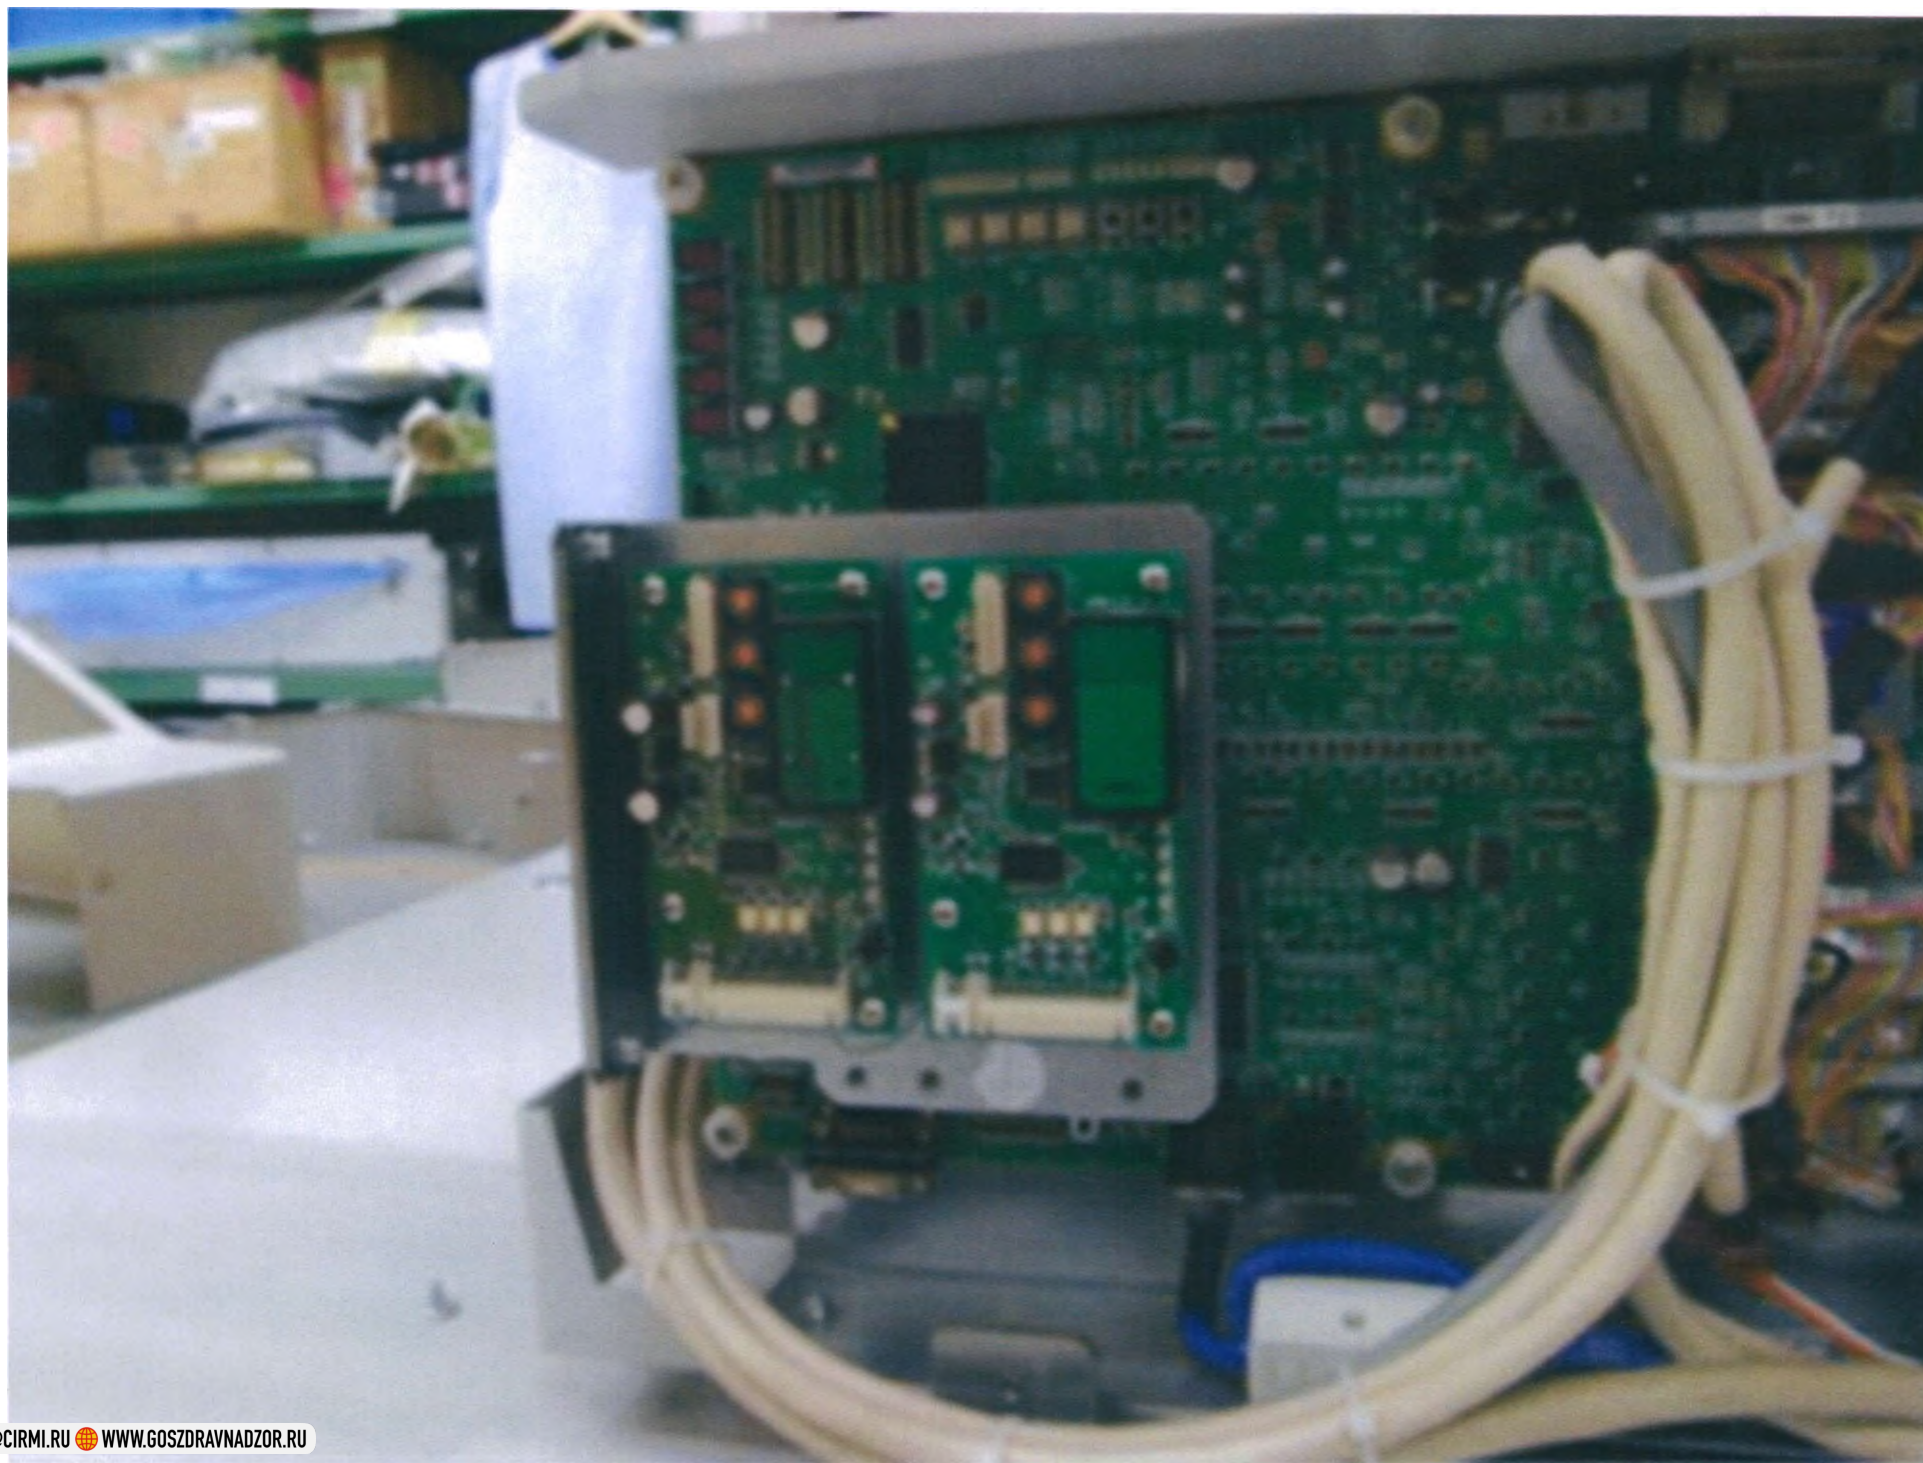


8. Комплект беспроводного ножного переключателя (для САТ-880В).

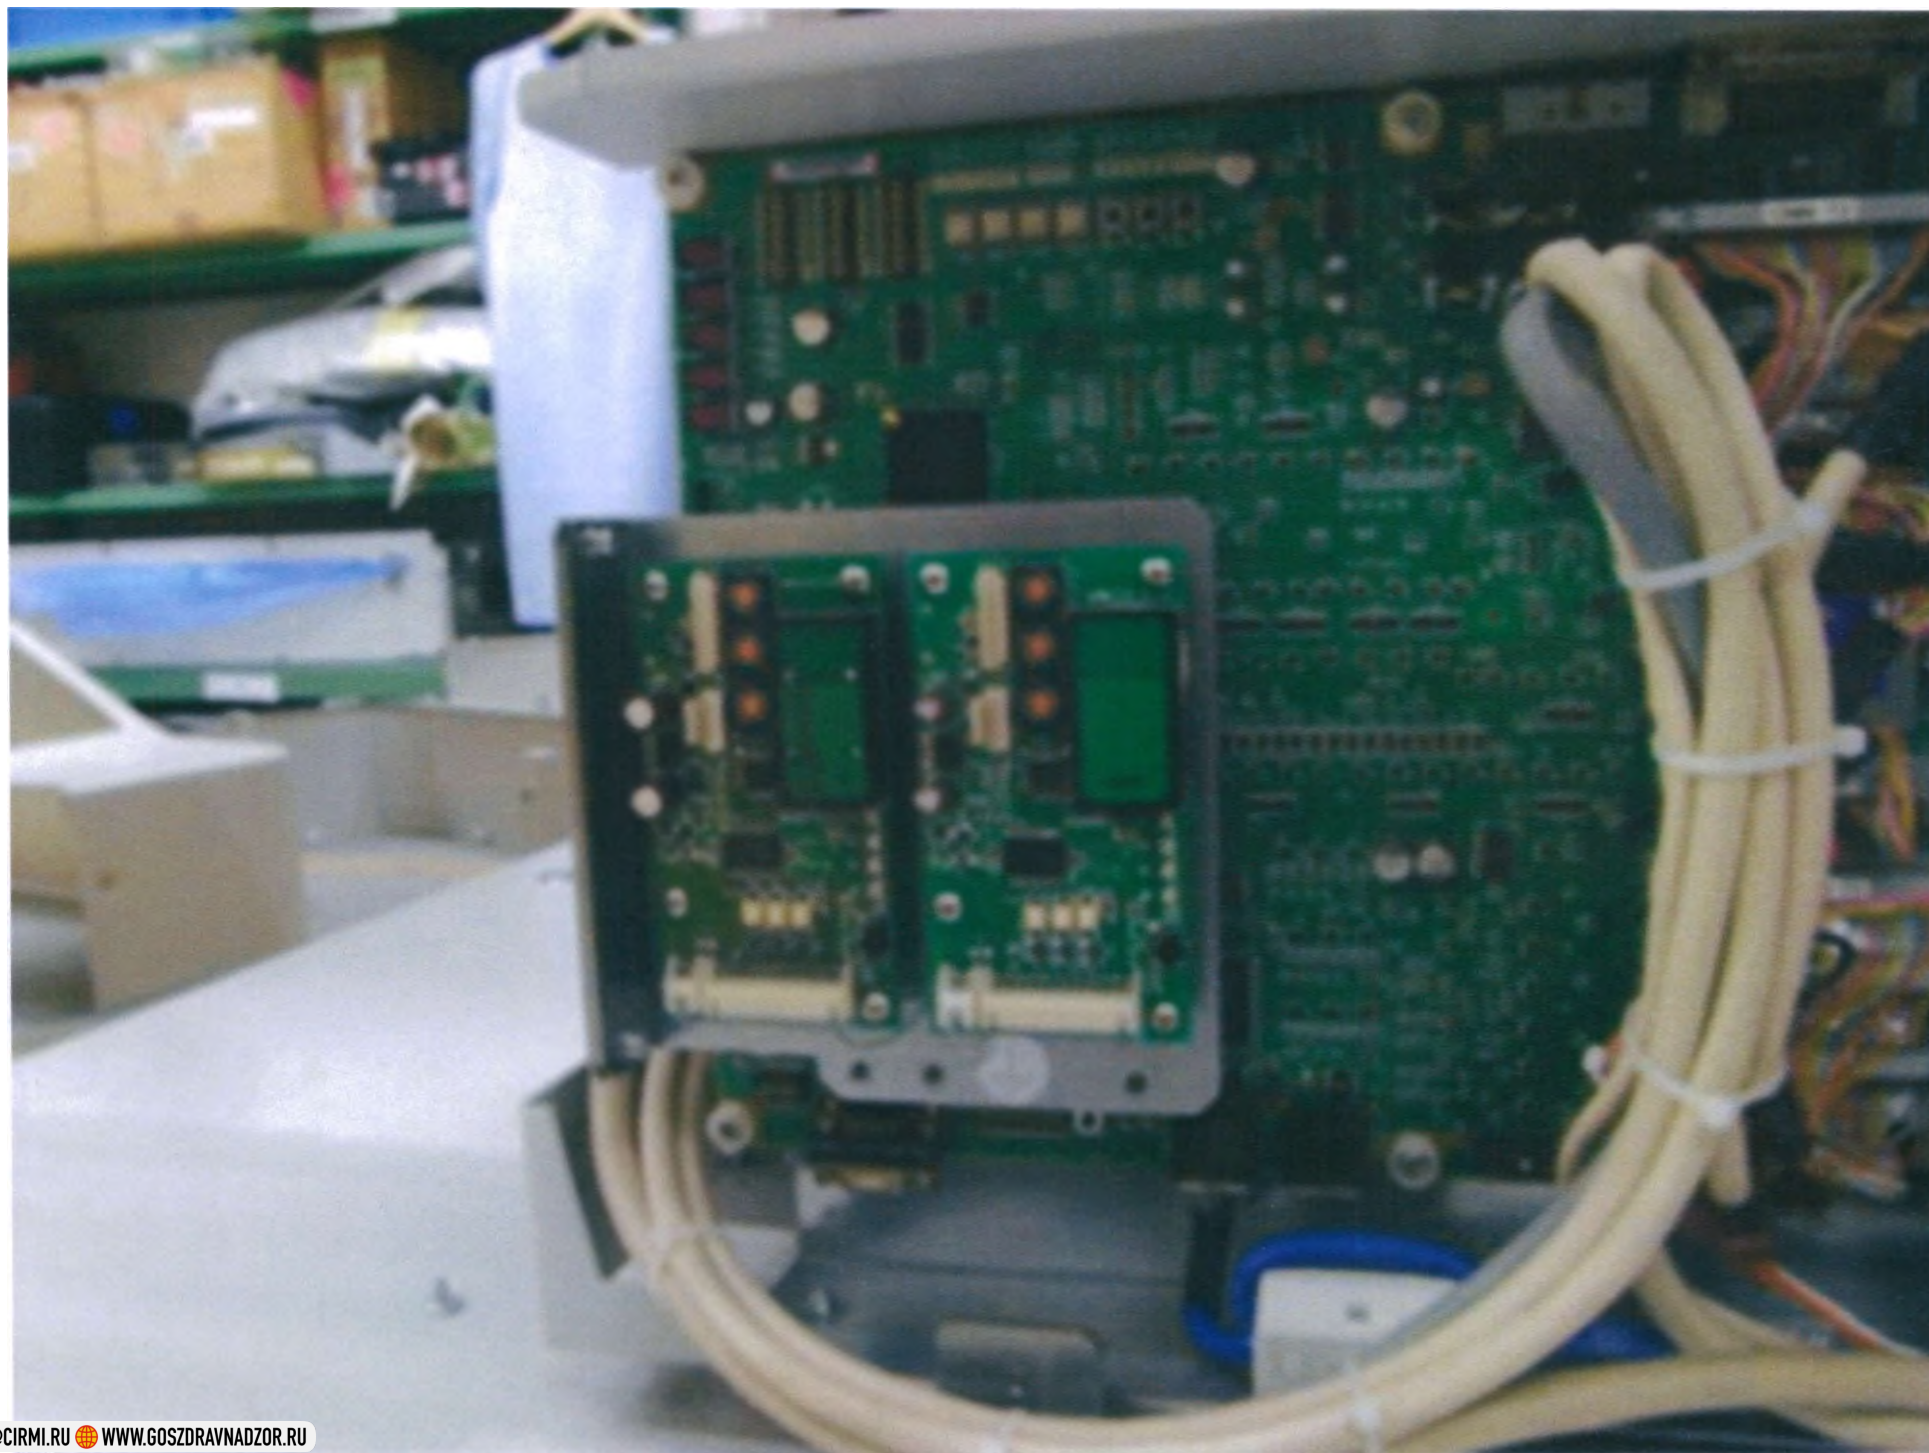


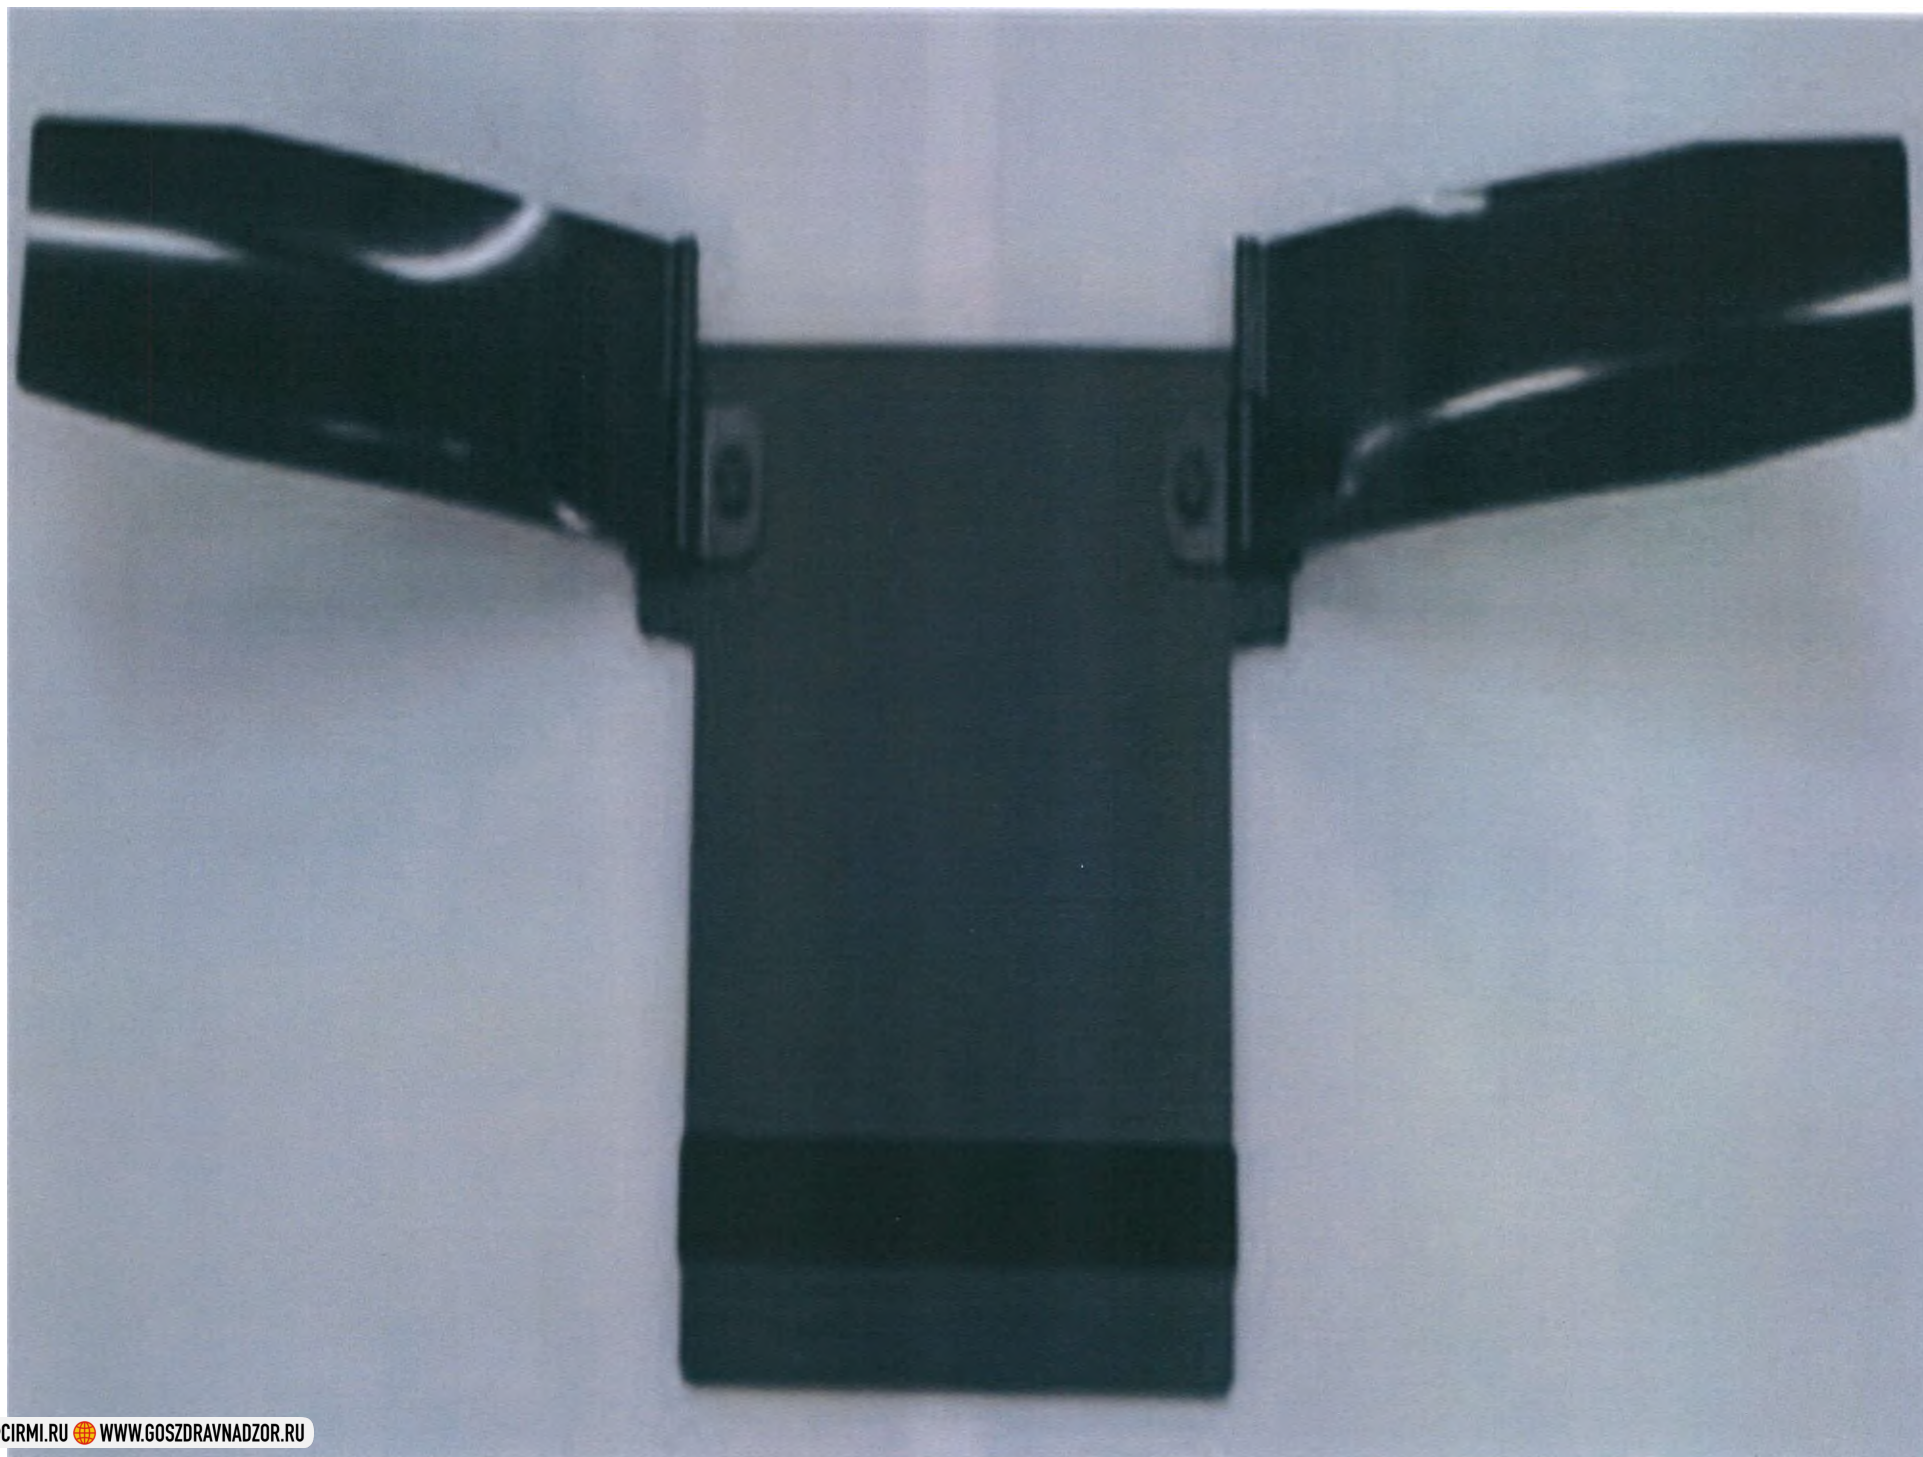


10. Подлокотник для одной руки (для САТ-880В).

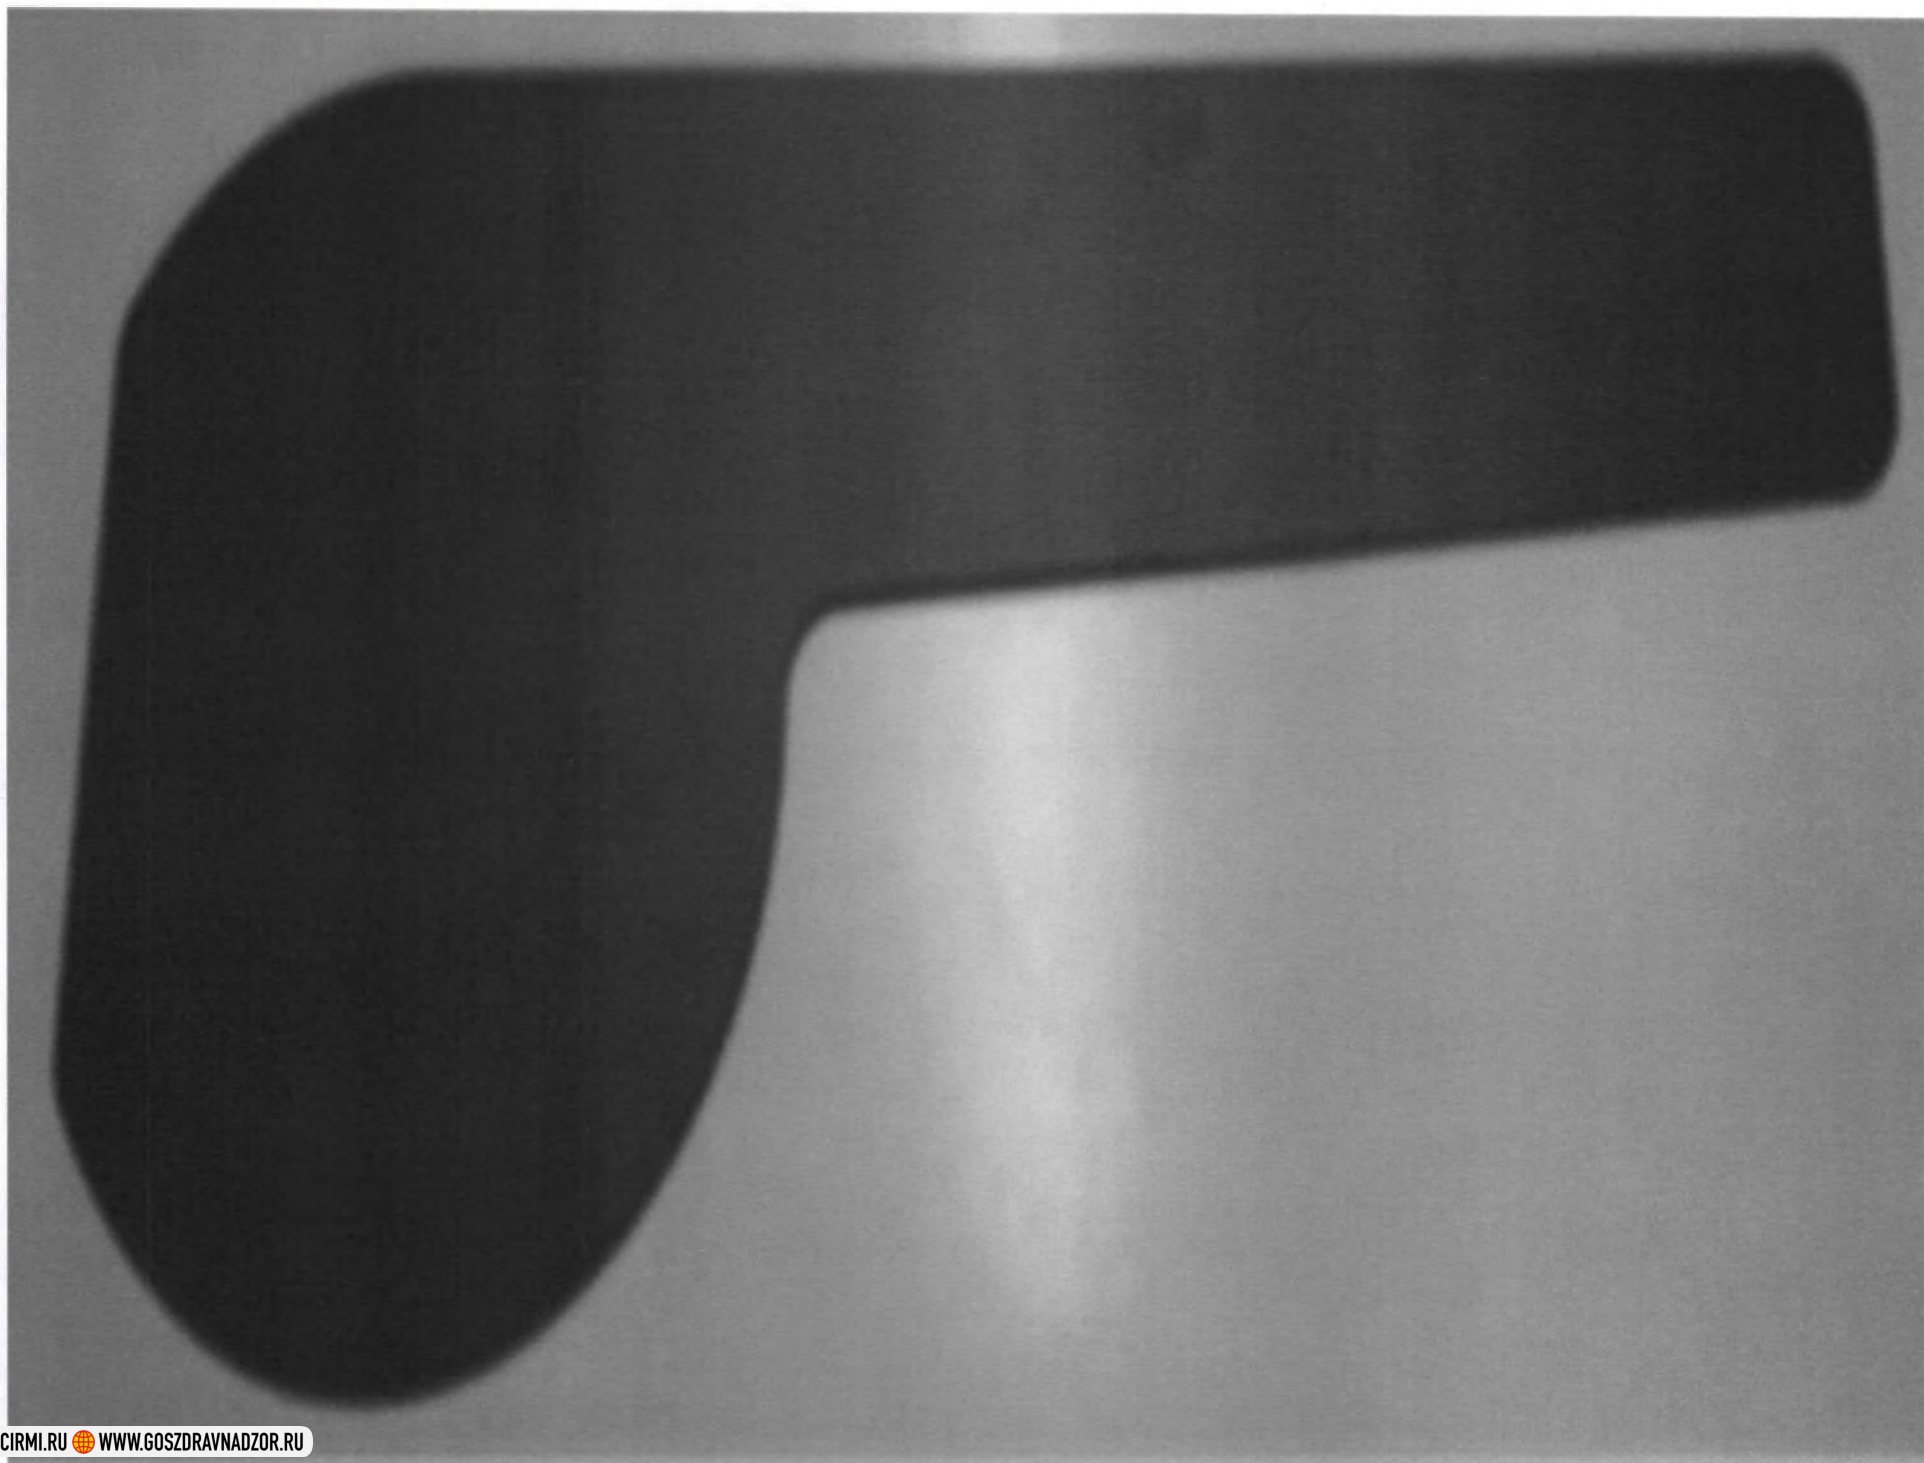




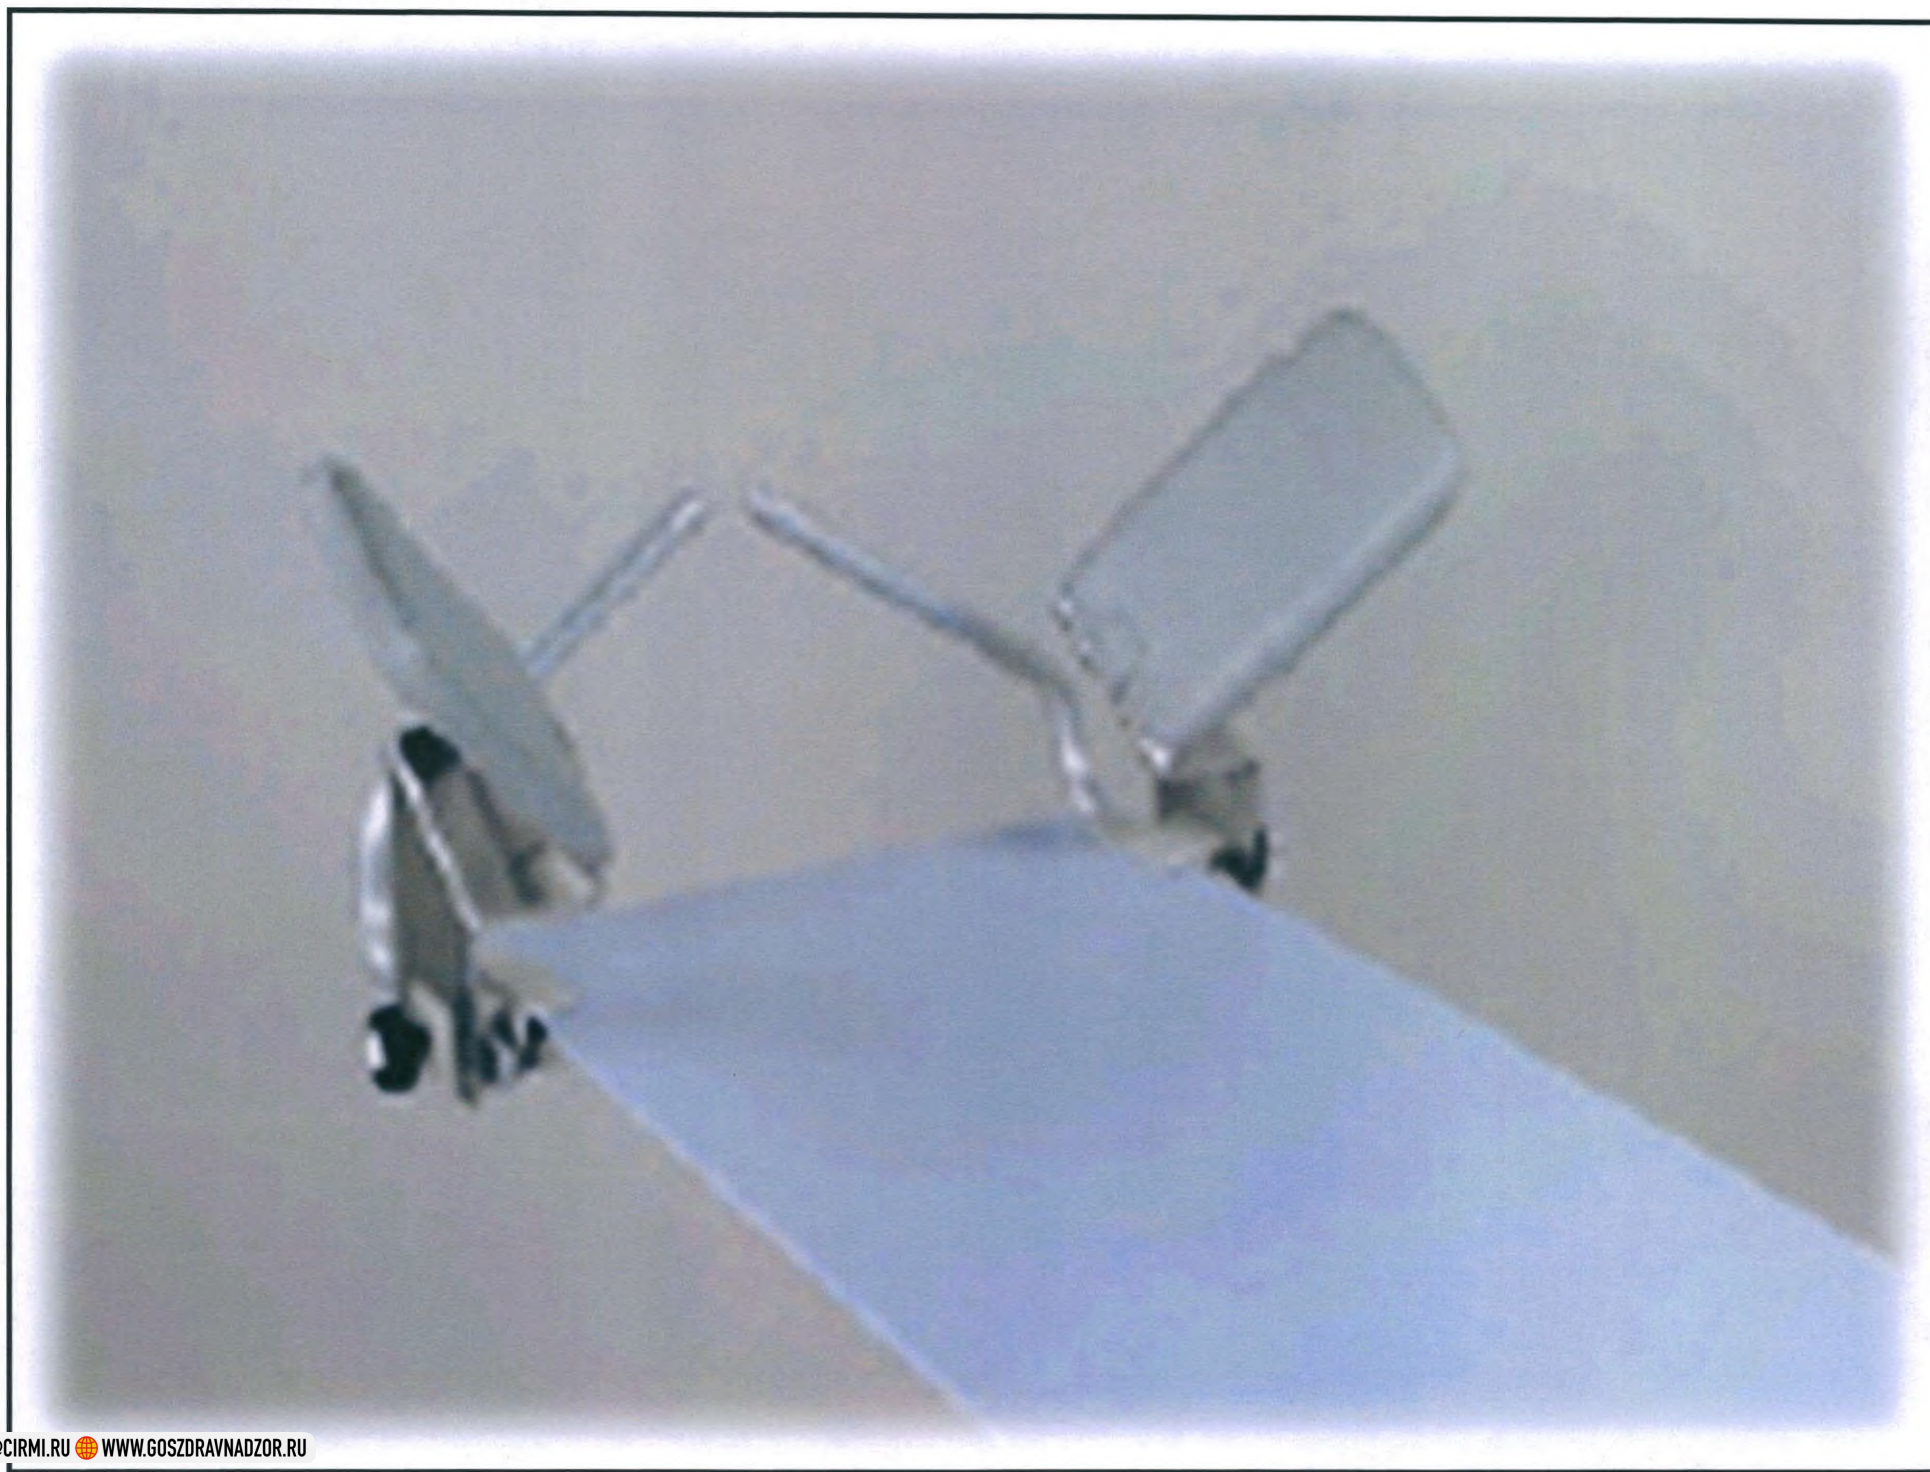

13. Нарукавник (панель для защиты рук).

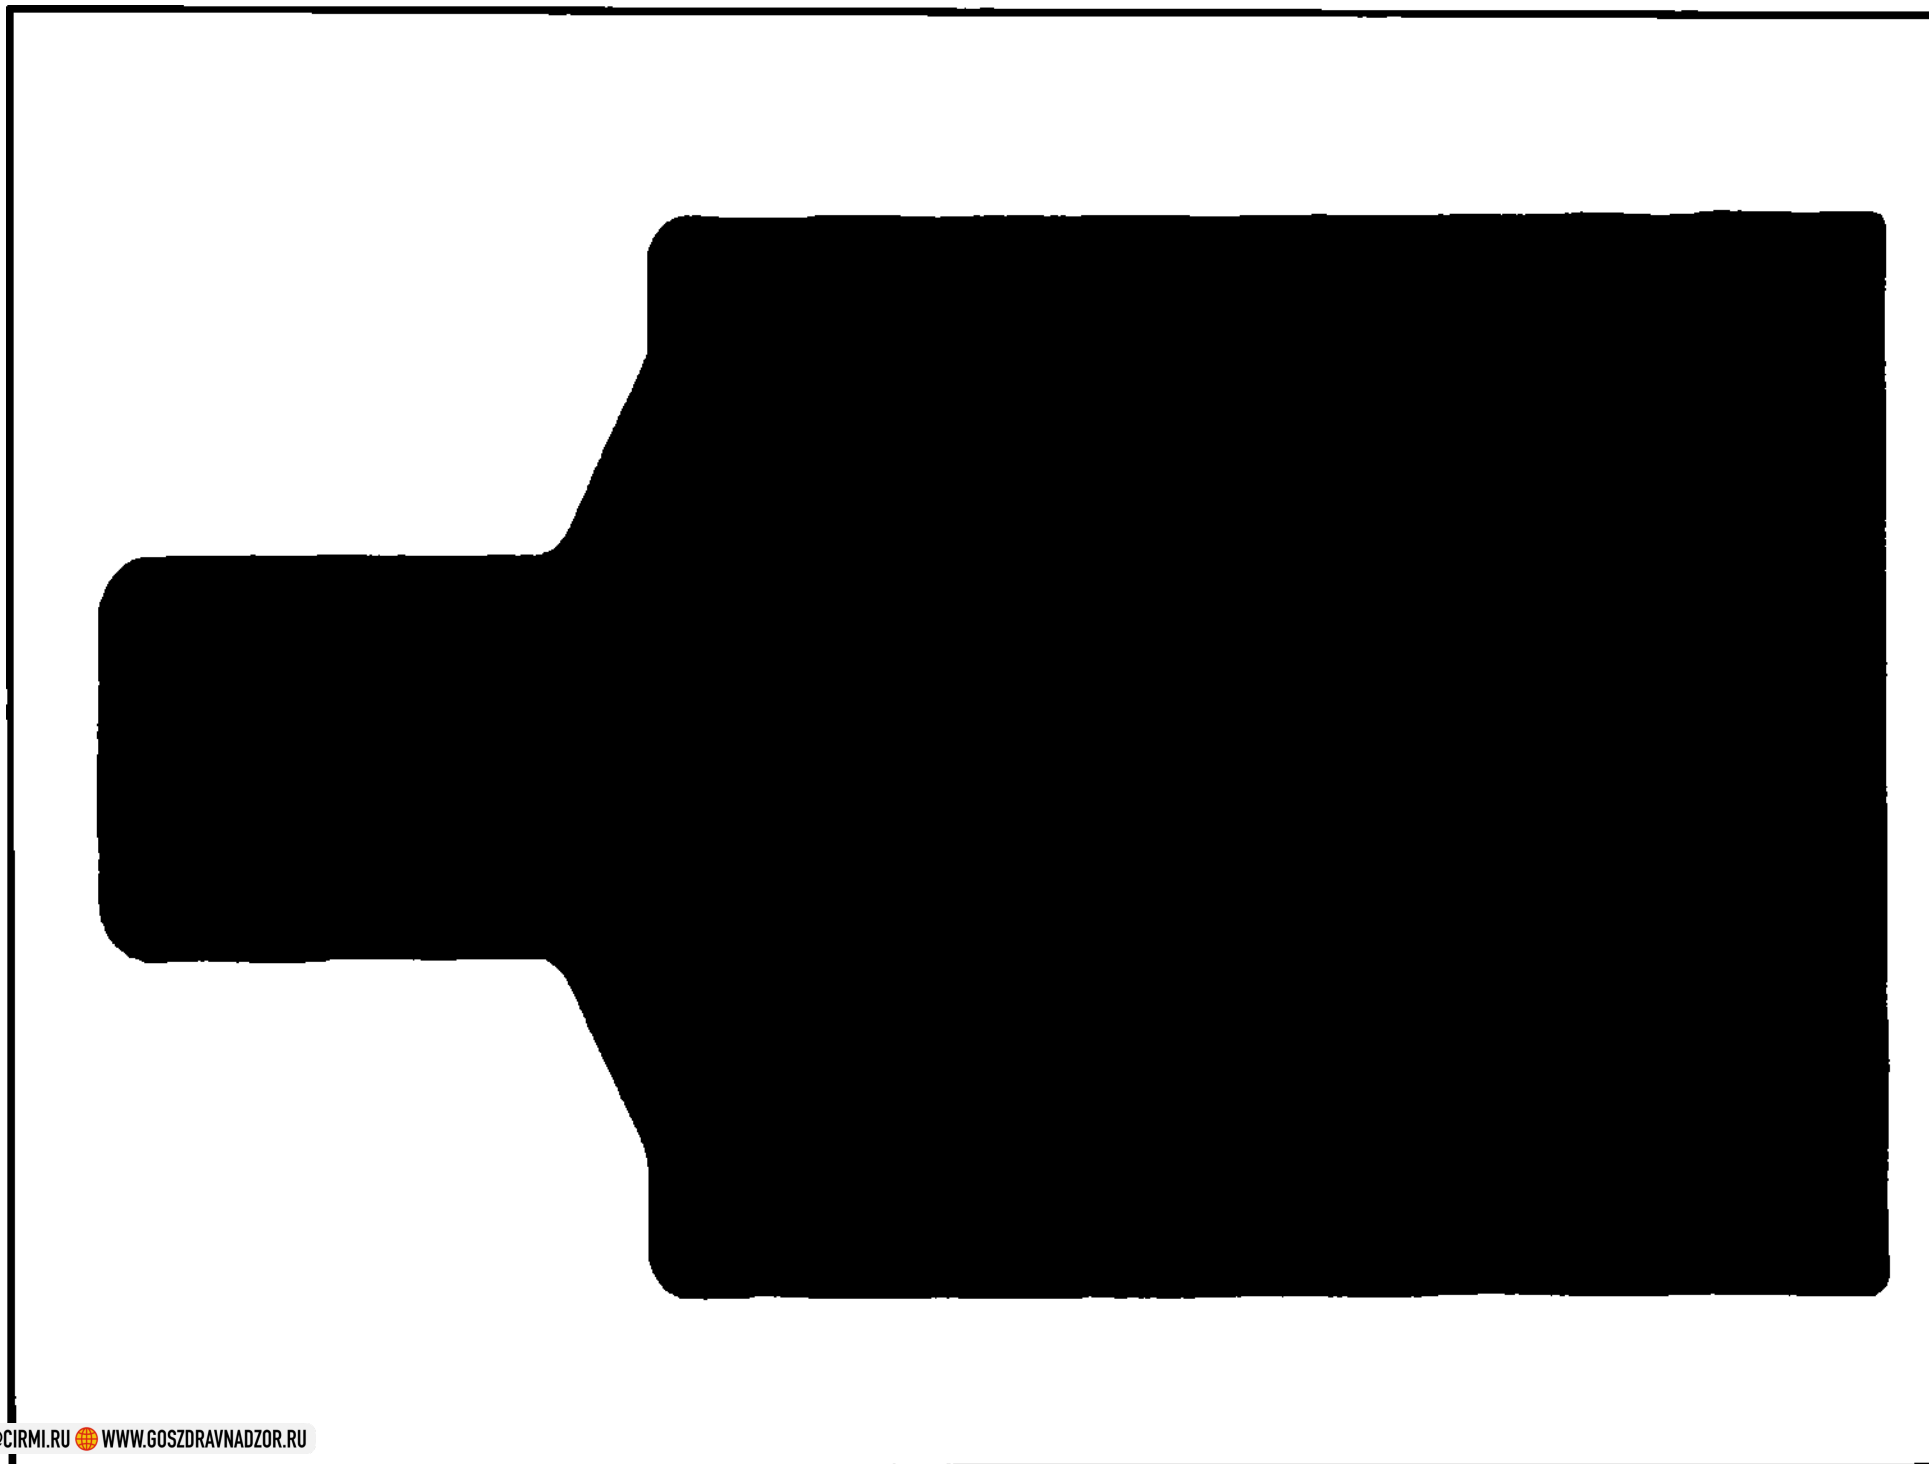


14. Дополнительная направляющая деки стола (для САТ-880В).

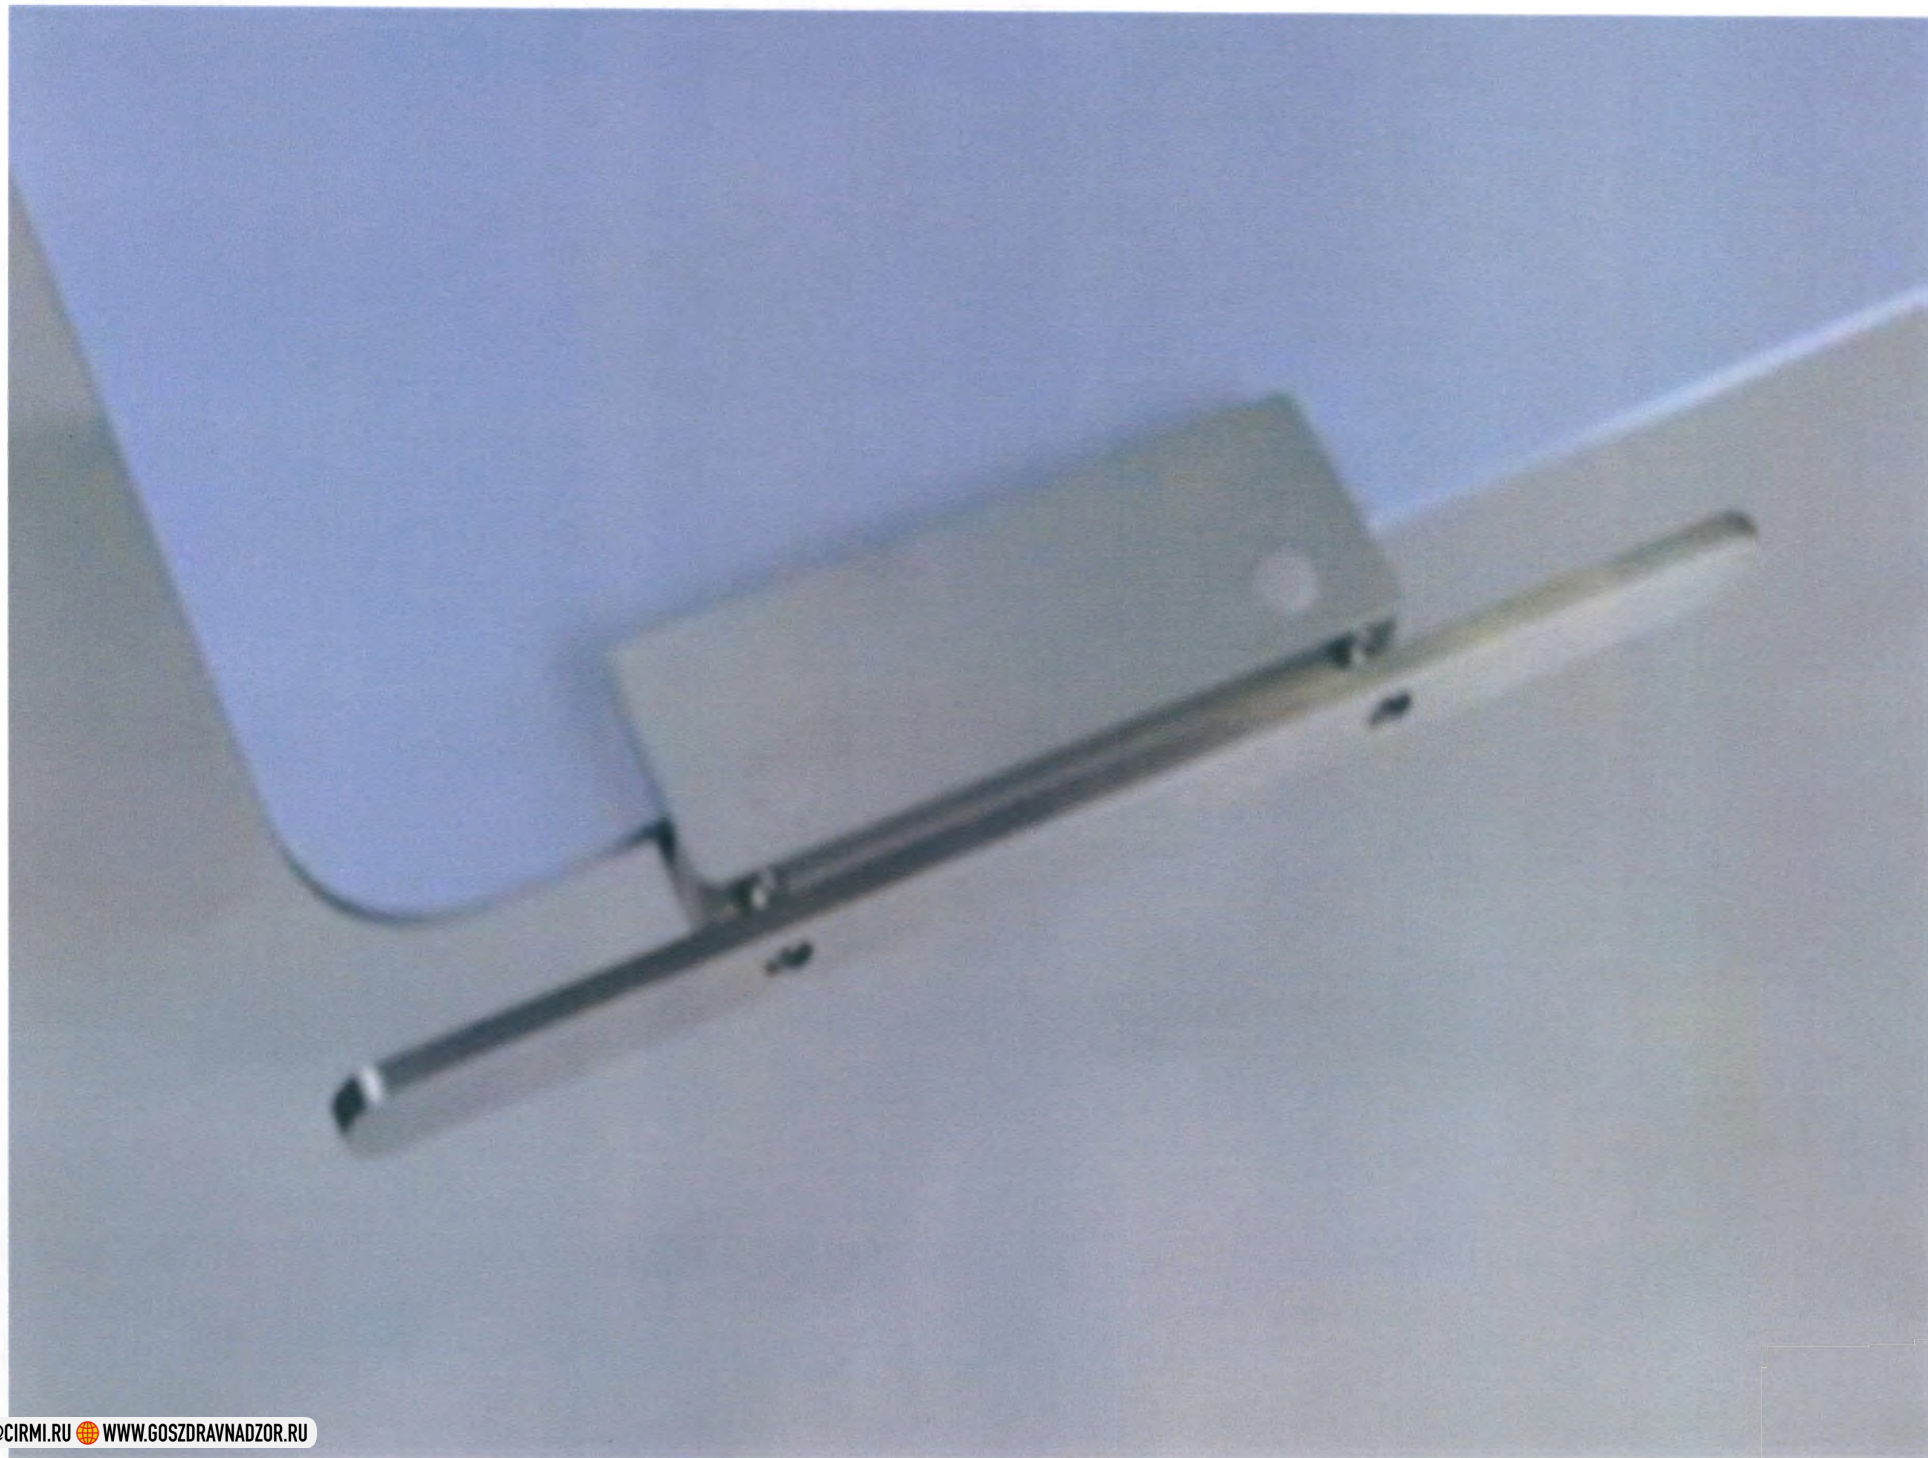


15. Держатель простыни (для САТ-880В).

009

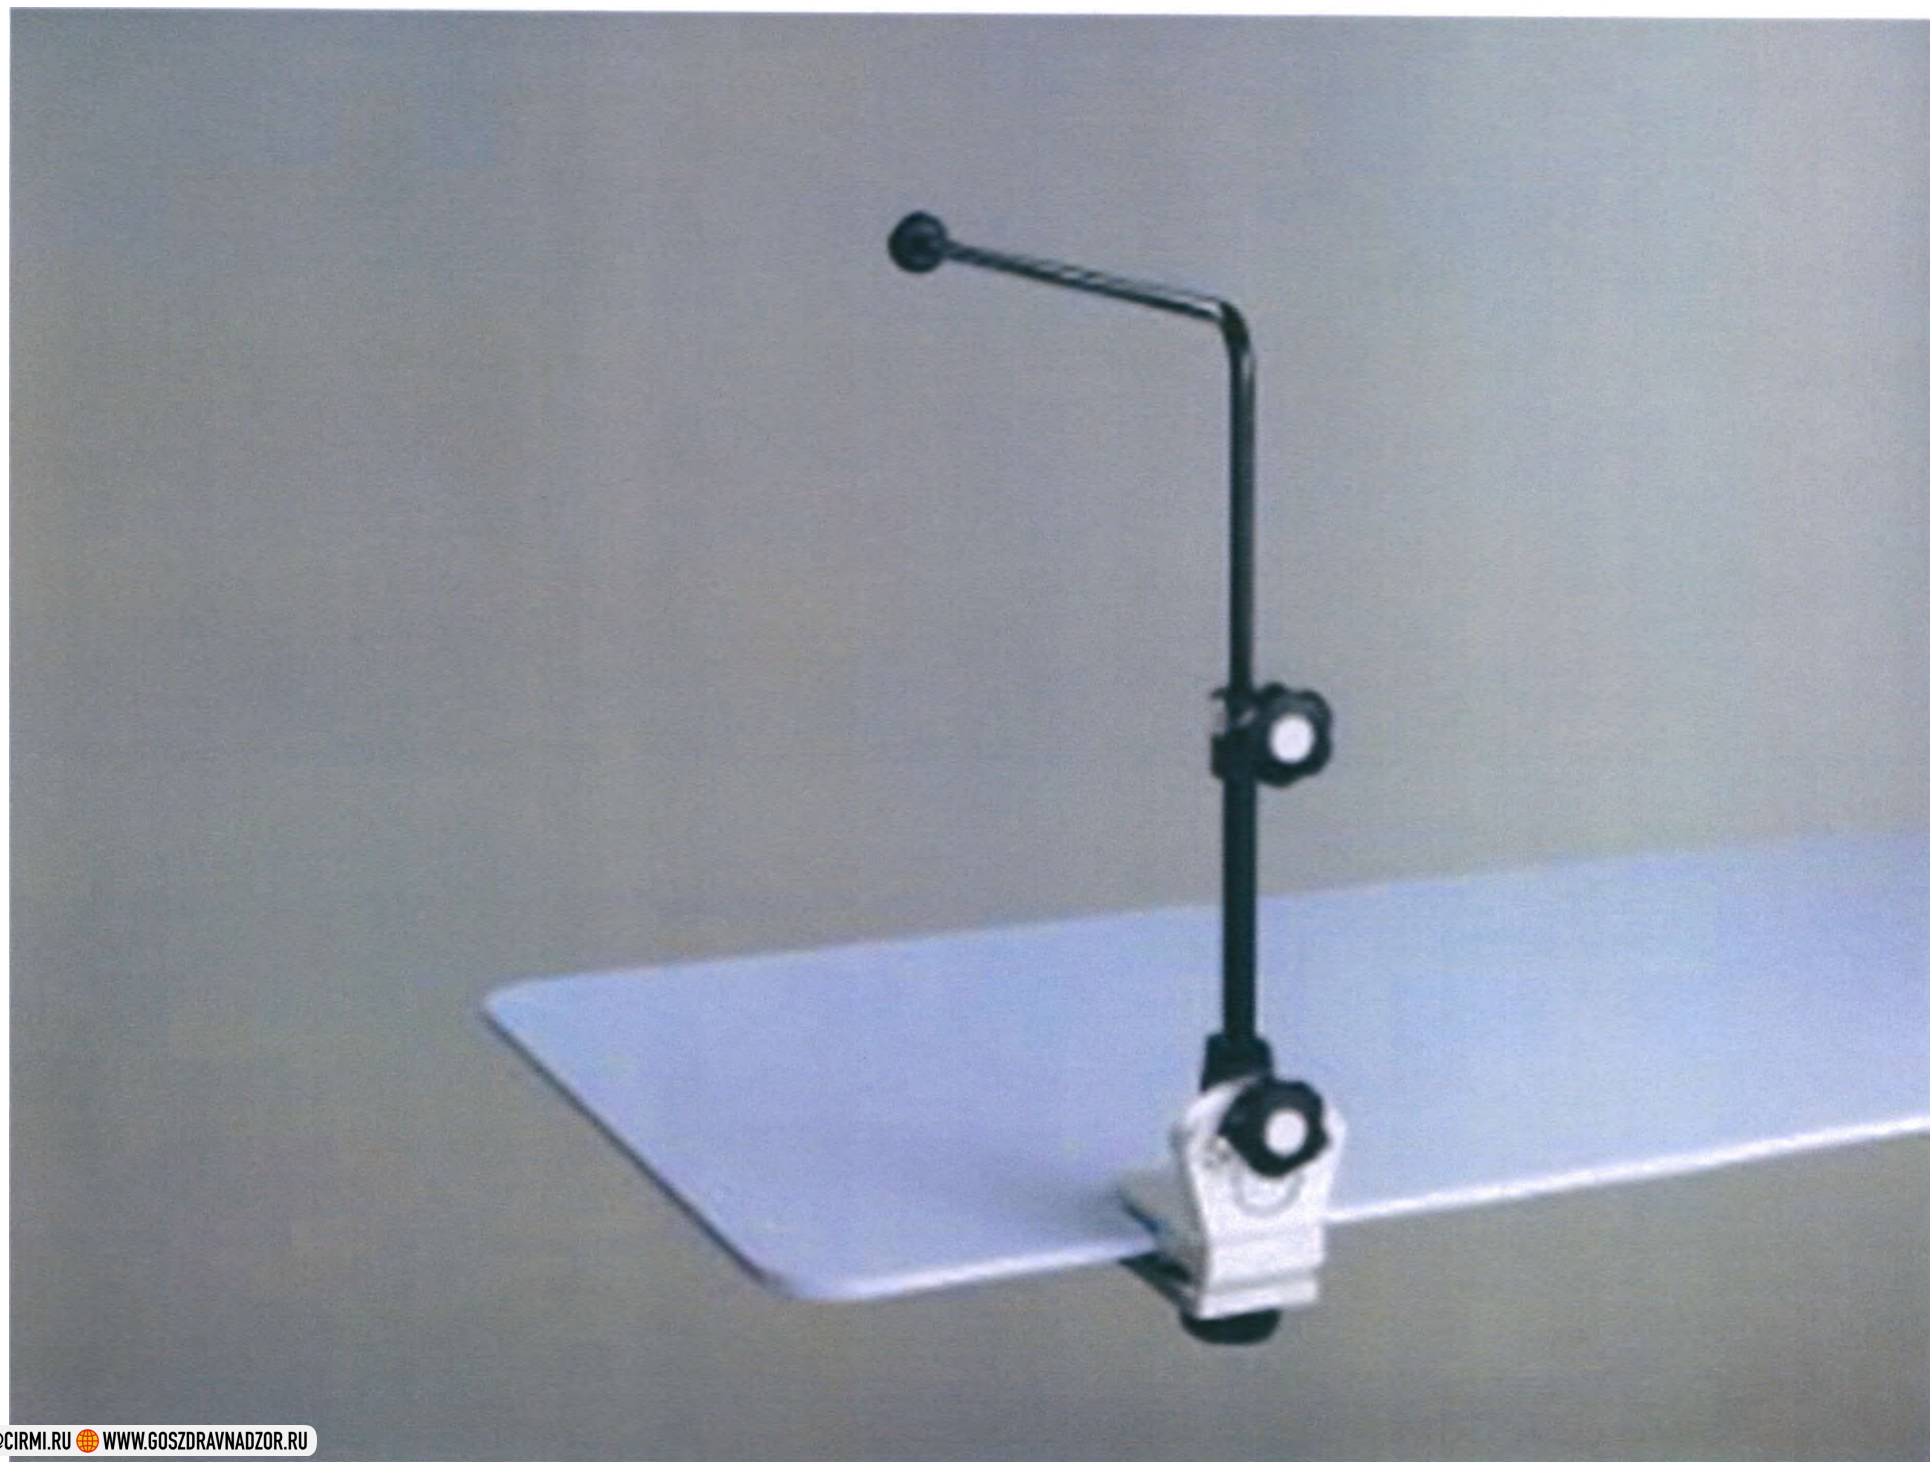





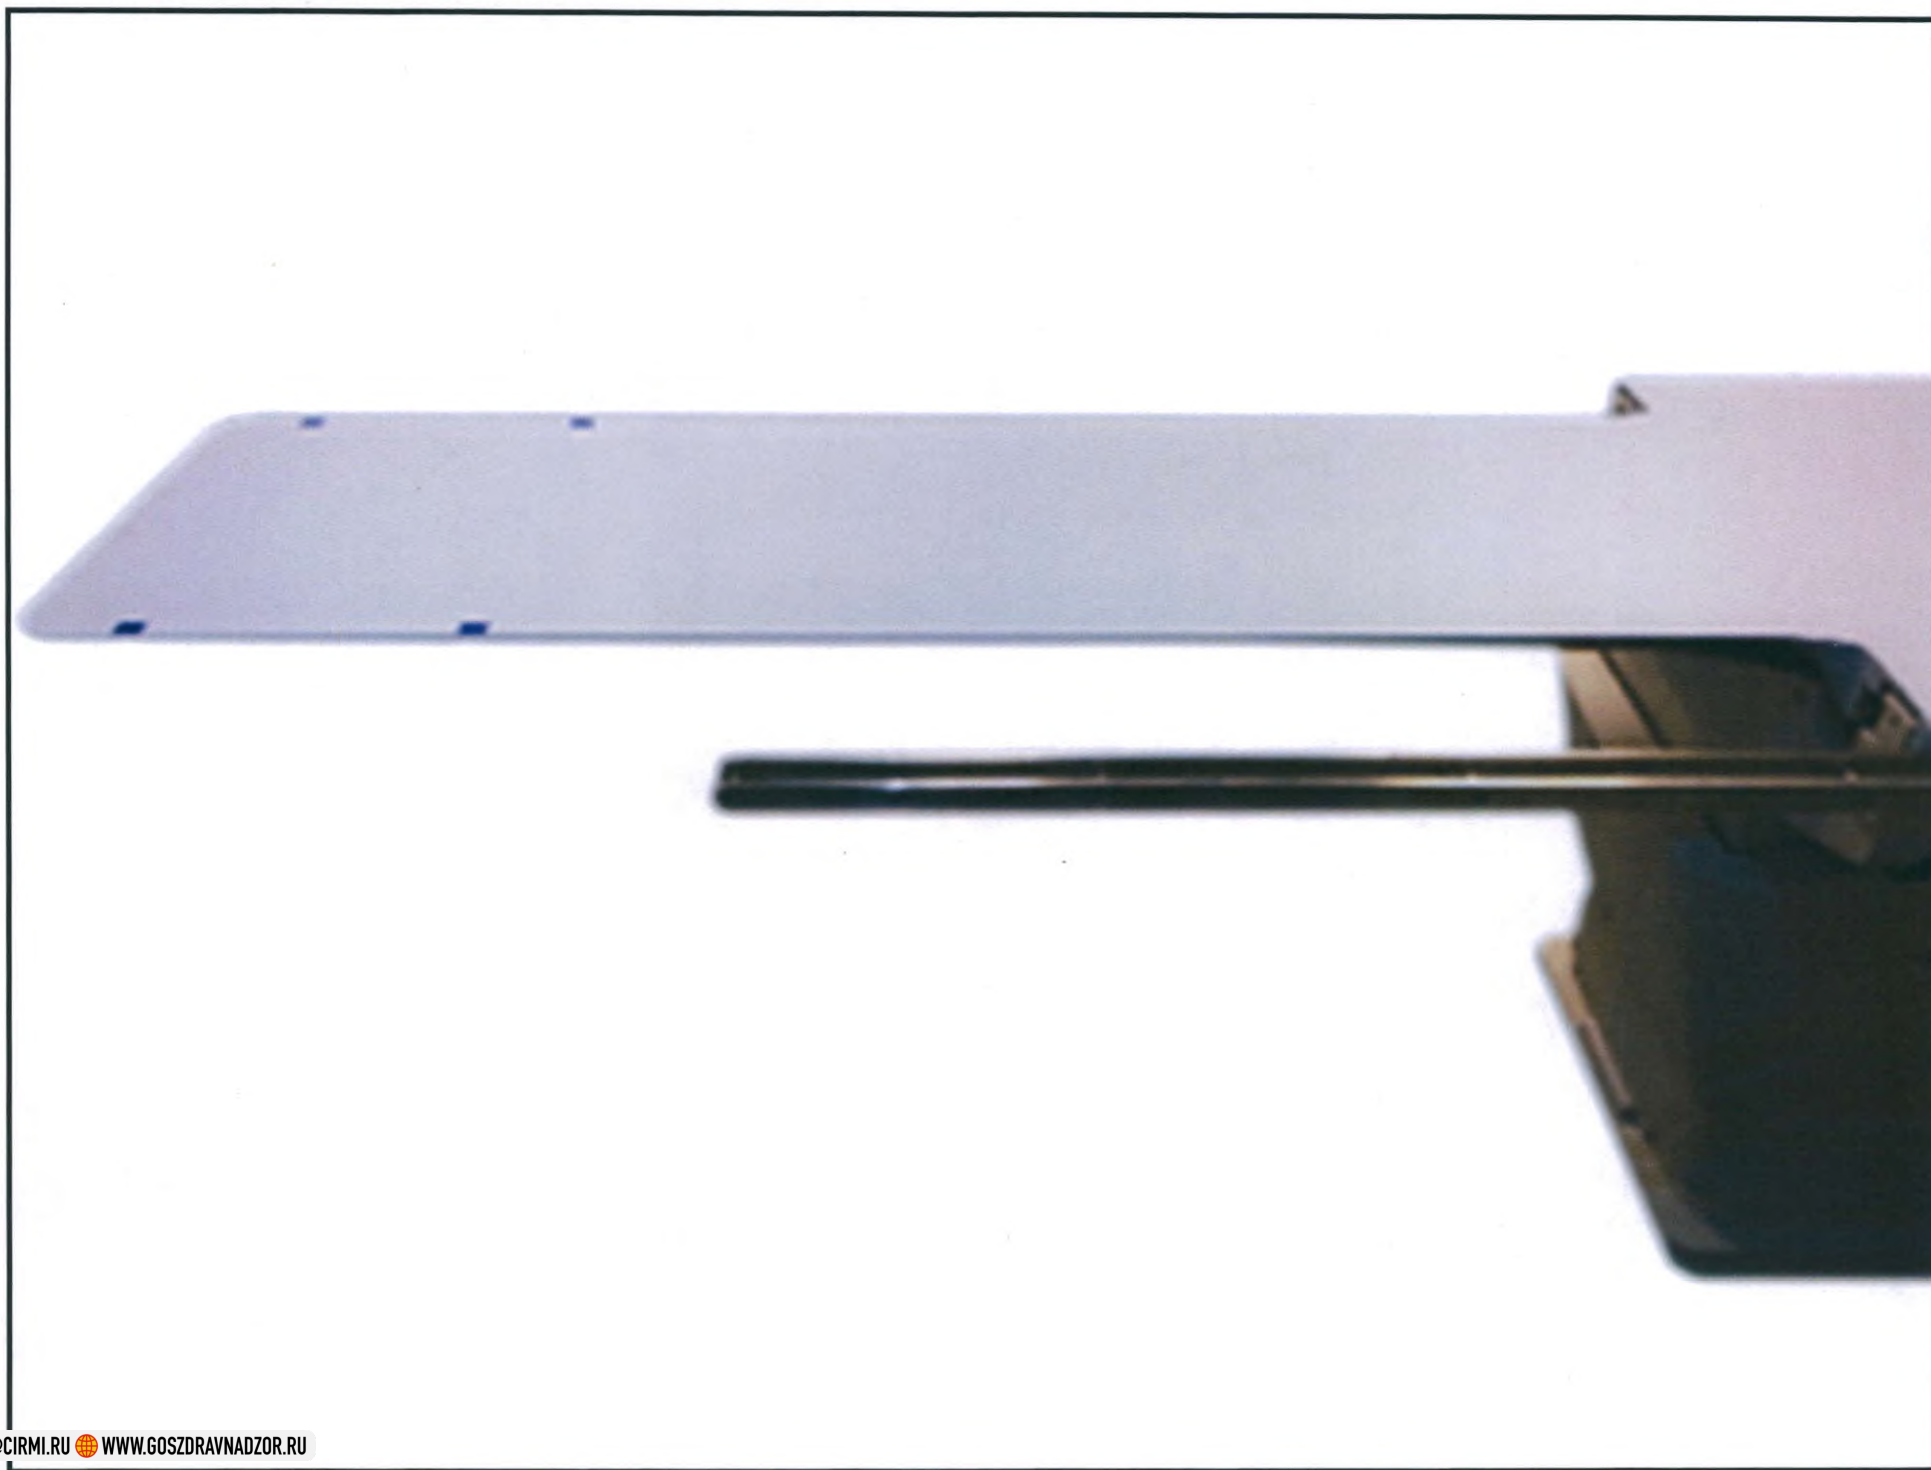



20. Комплект управляющего переключателя стола на головном конце (для CAT-850В).




21. Накладка для деки стола толщиной 5 см (для CAT-850В).







23. Вспомогательная планшетная консоль.

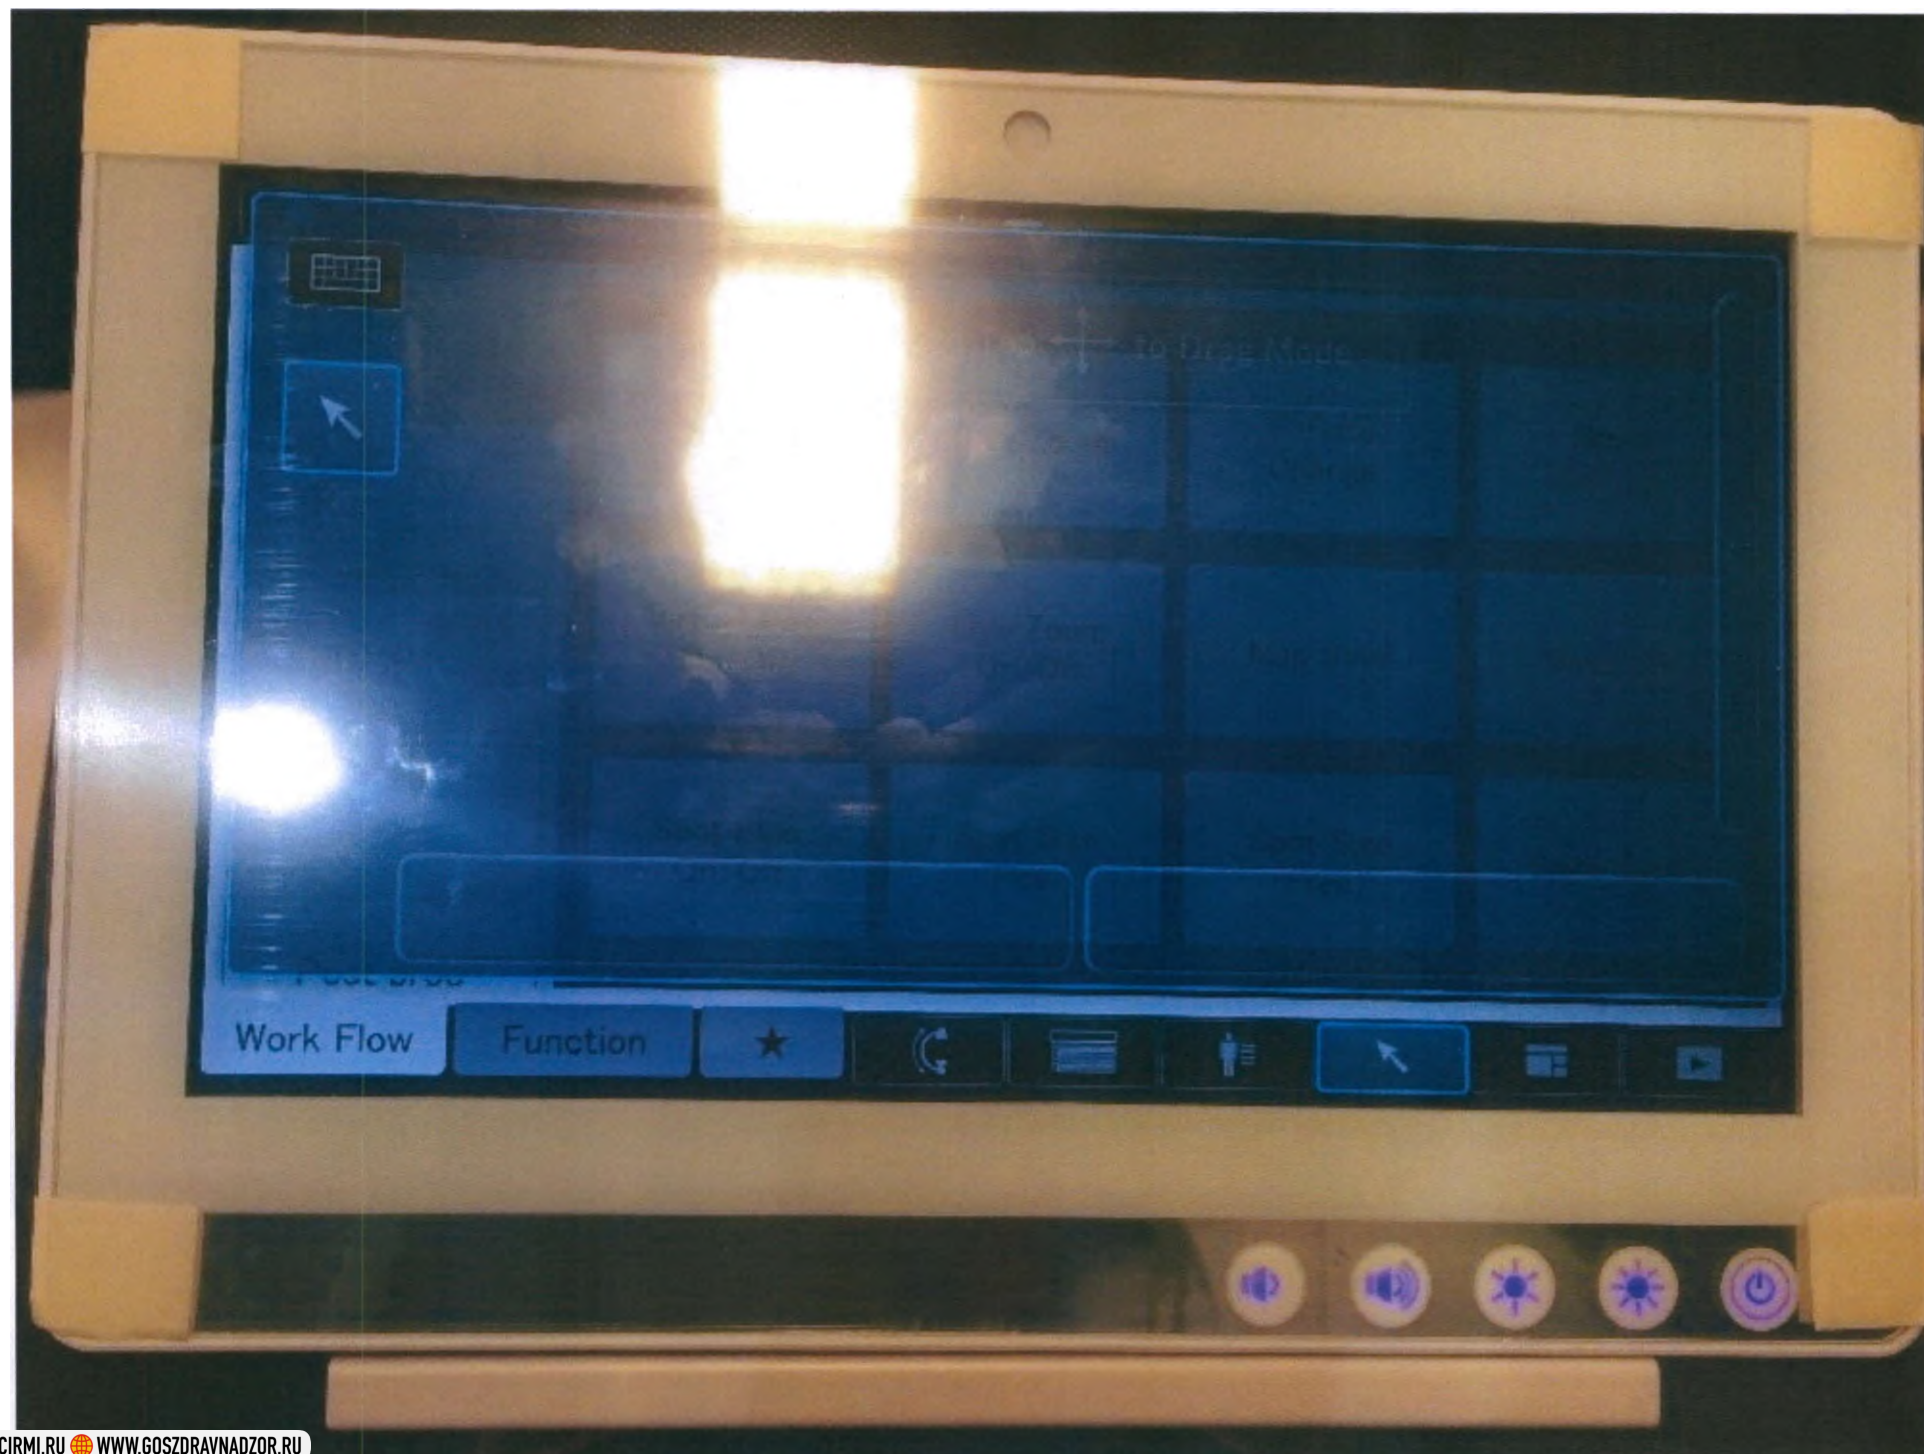


23. Вспомогательная планшетная консоль (Подставка для планшетной консоли).

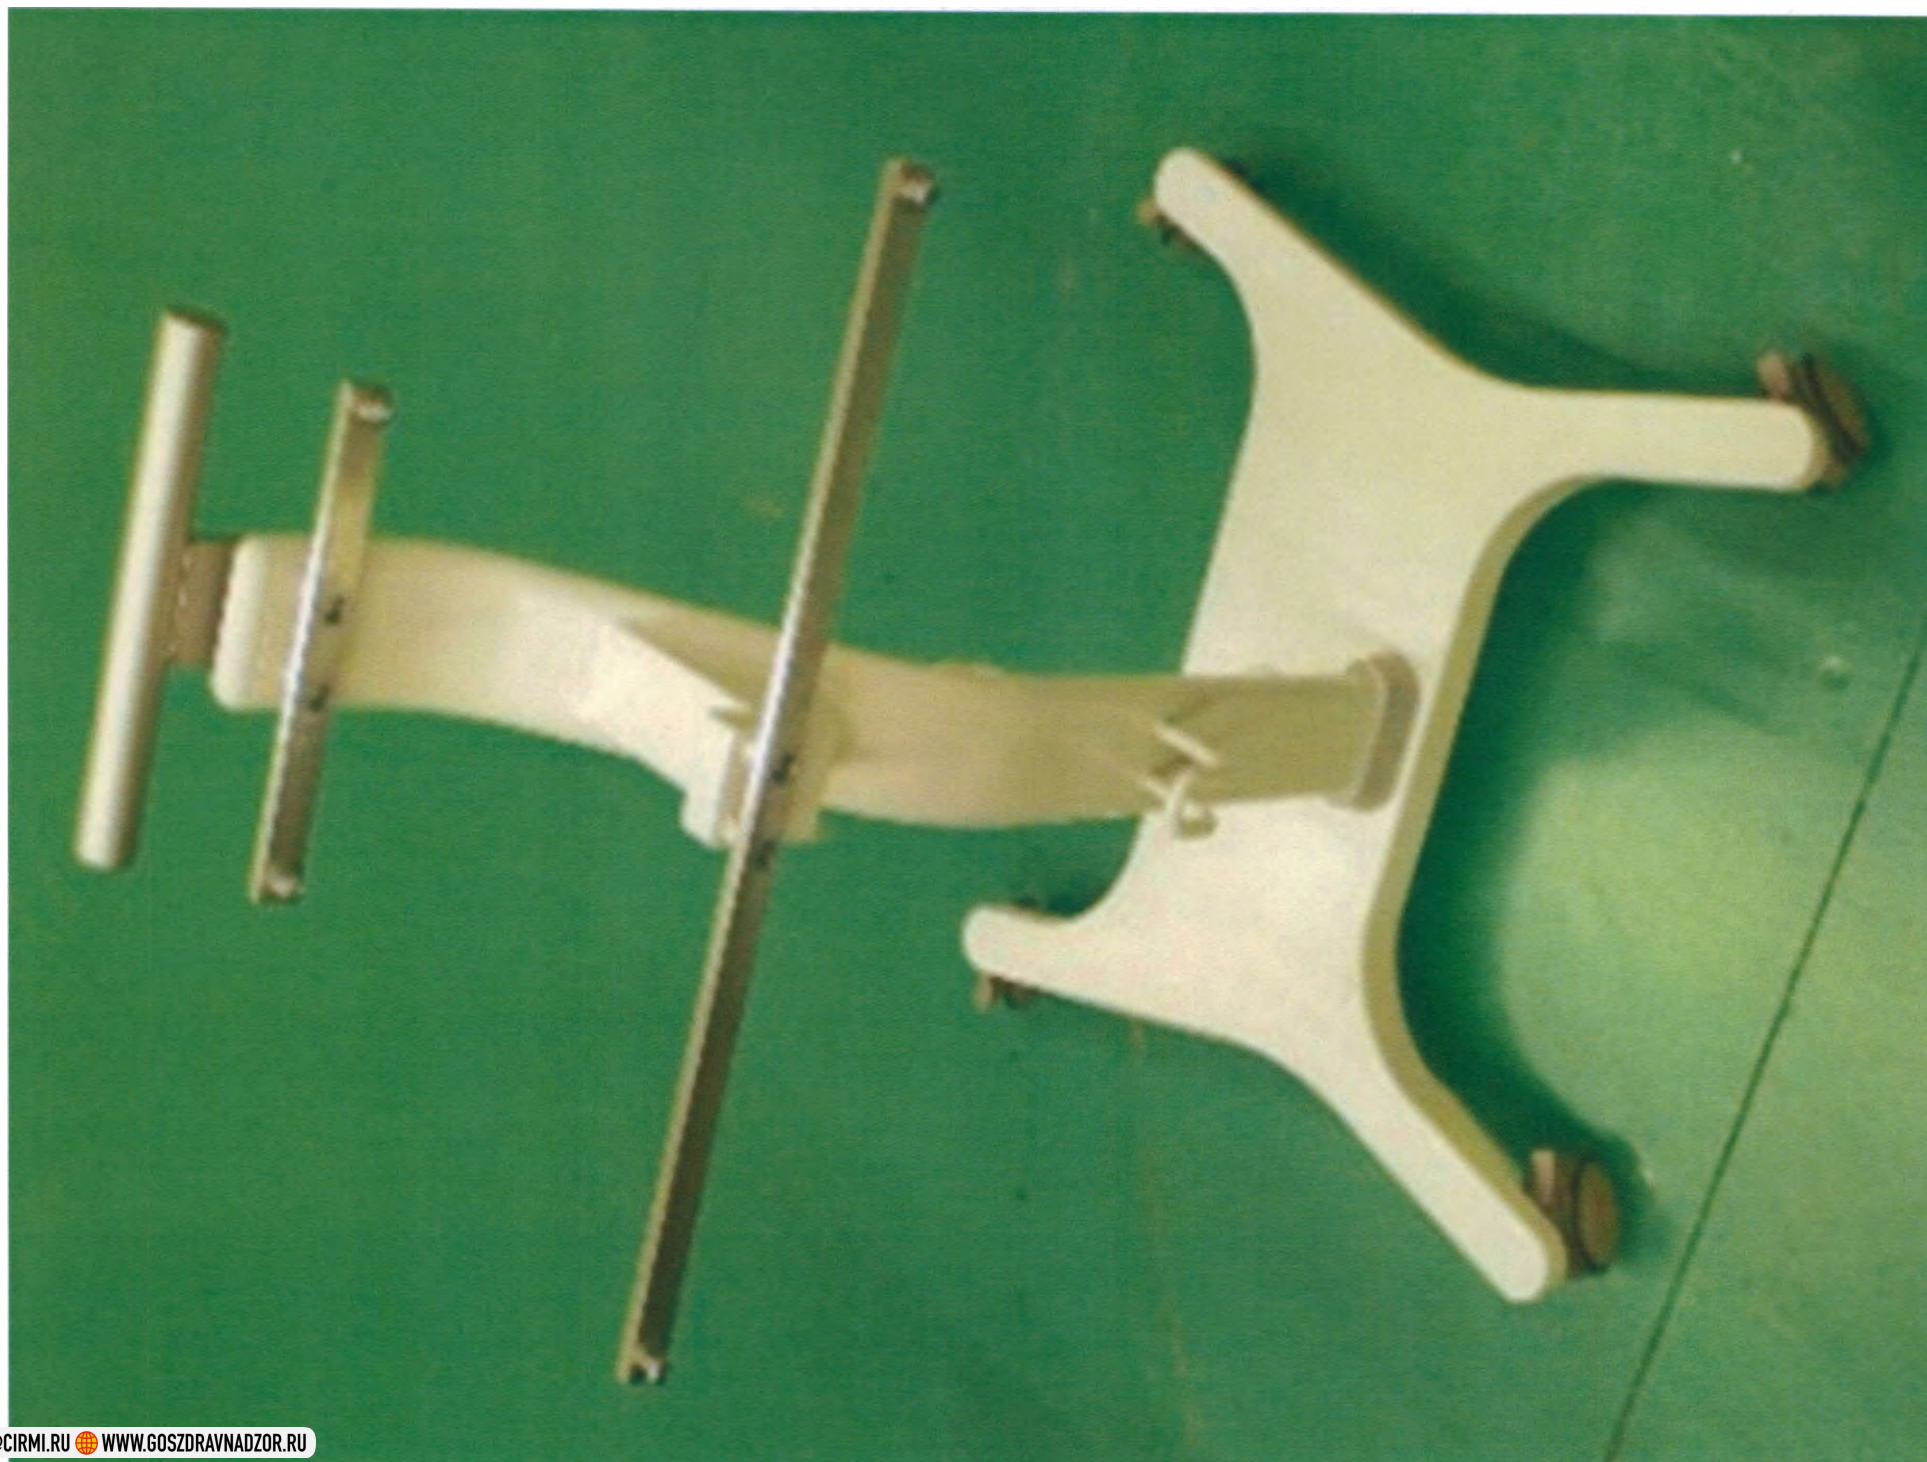



24. Боковая планшетная консоль стола с блоком переключателей.

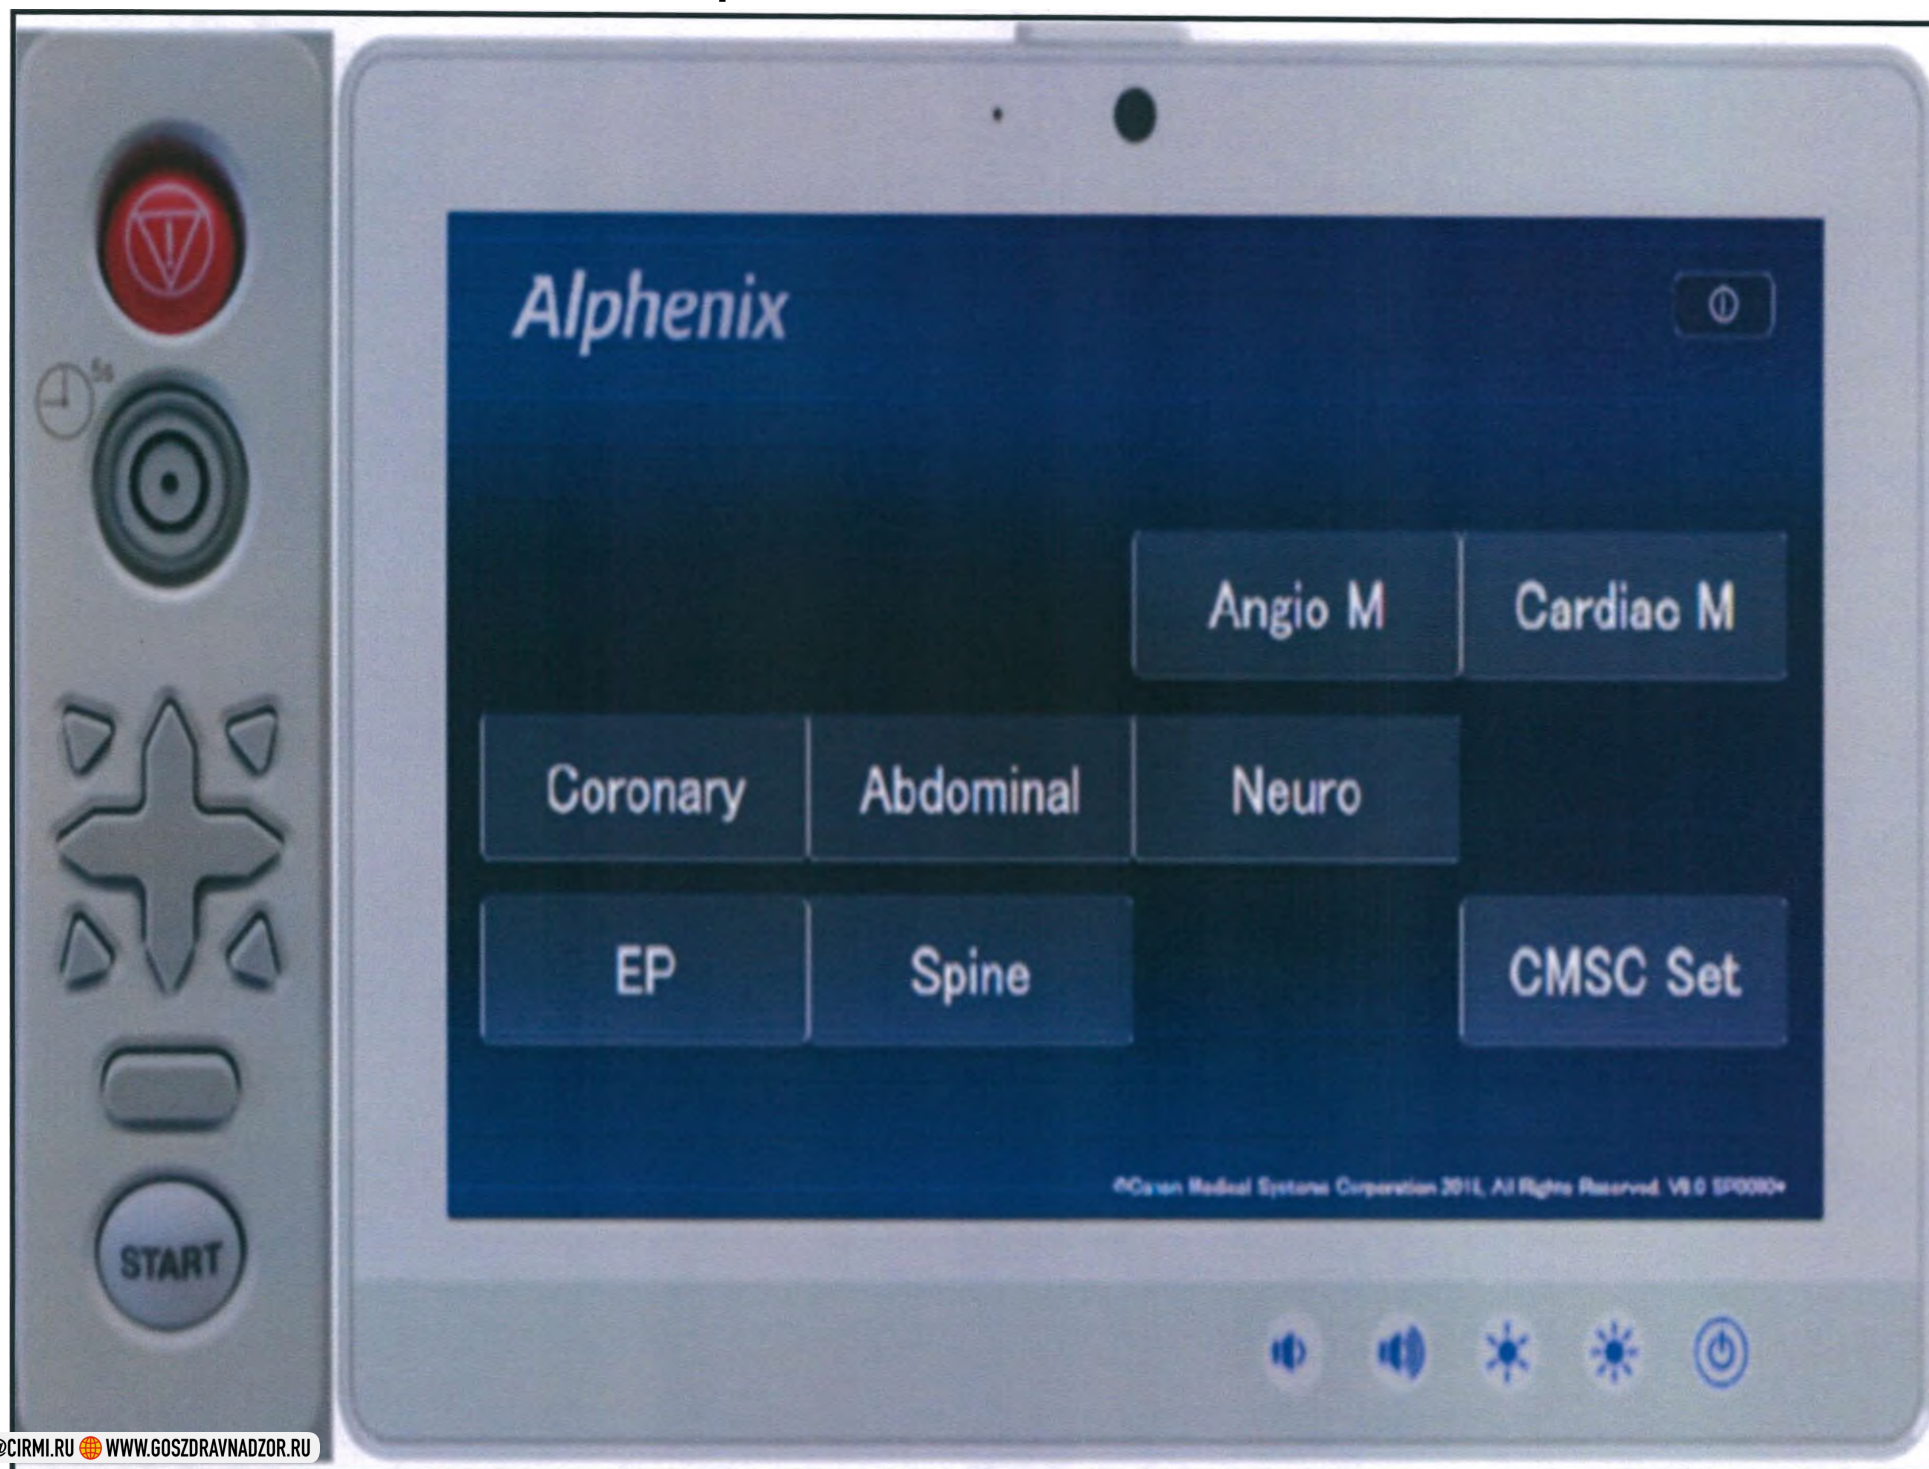

25. Вспомогательная планшетная консоль с блоком переключателей.

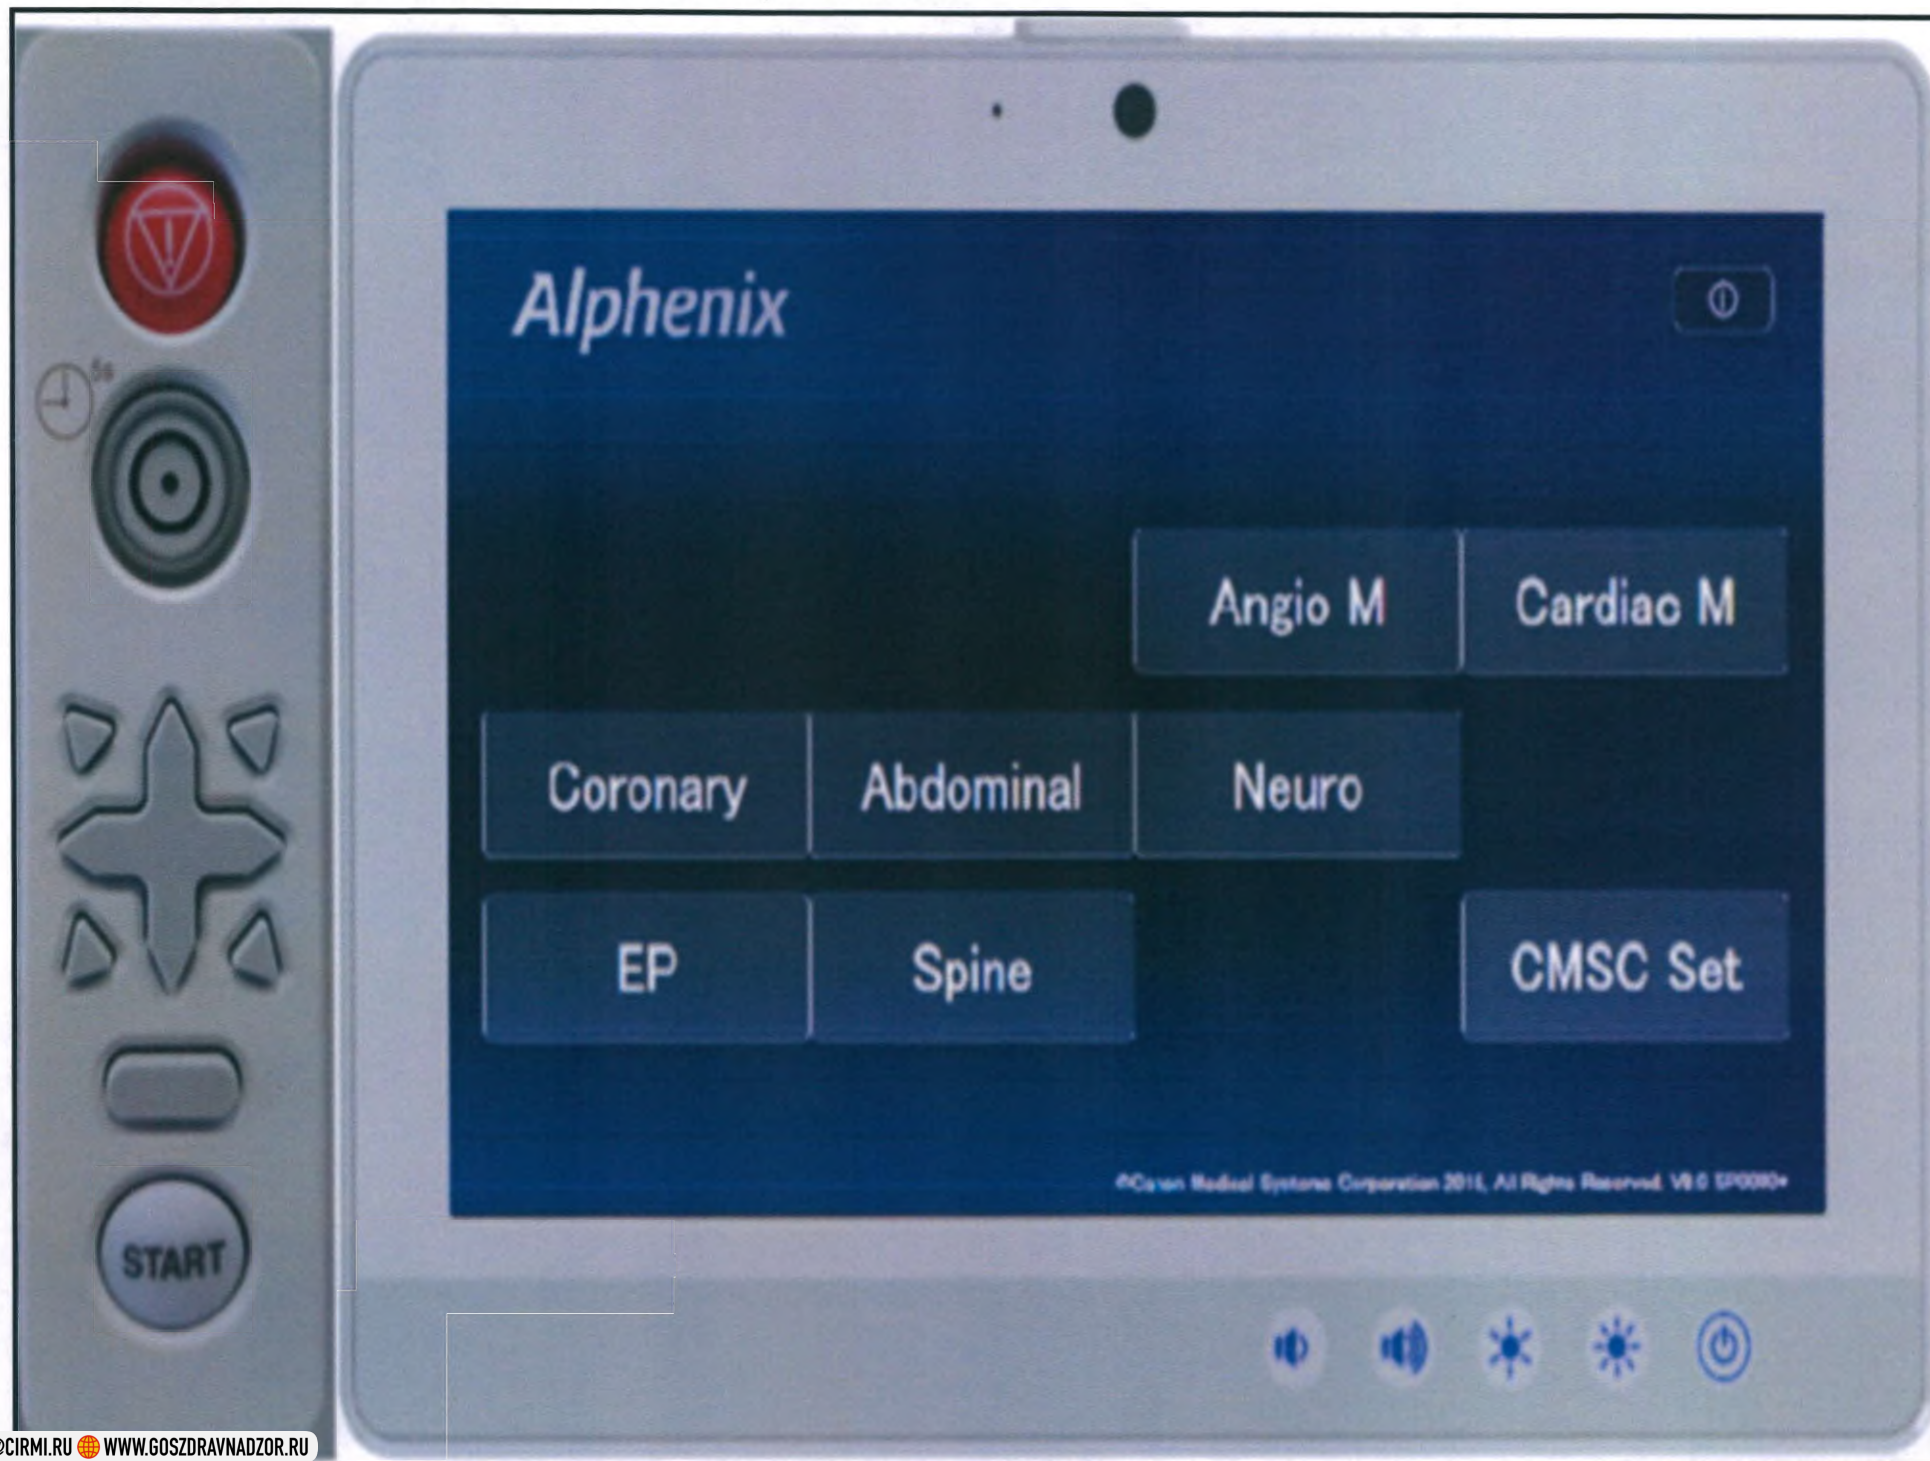

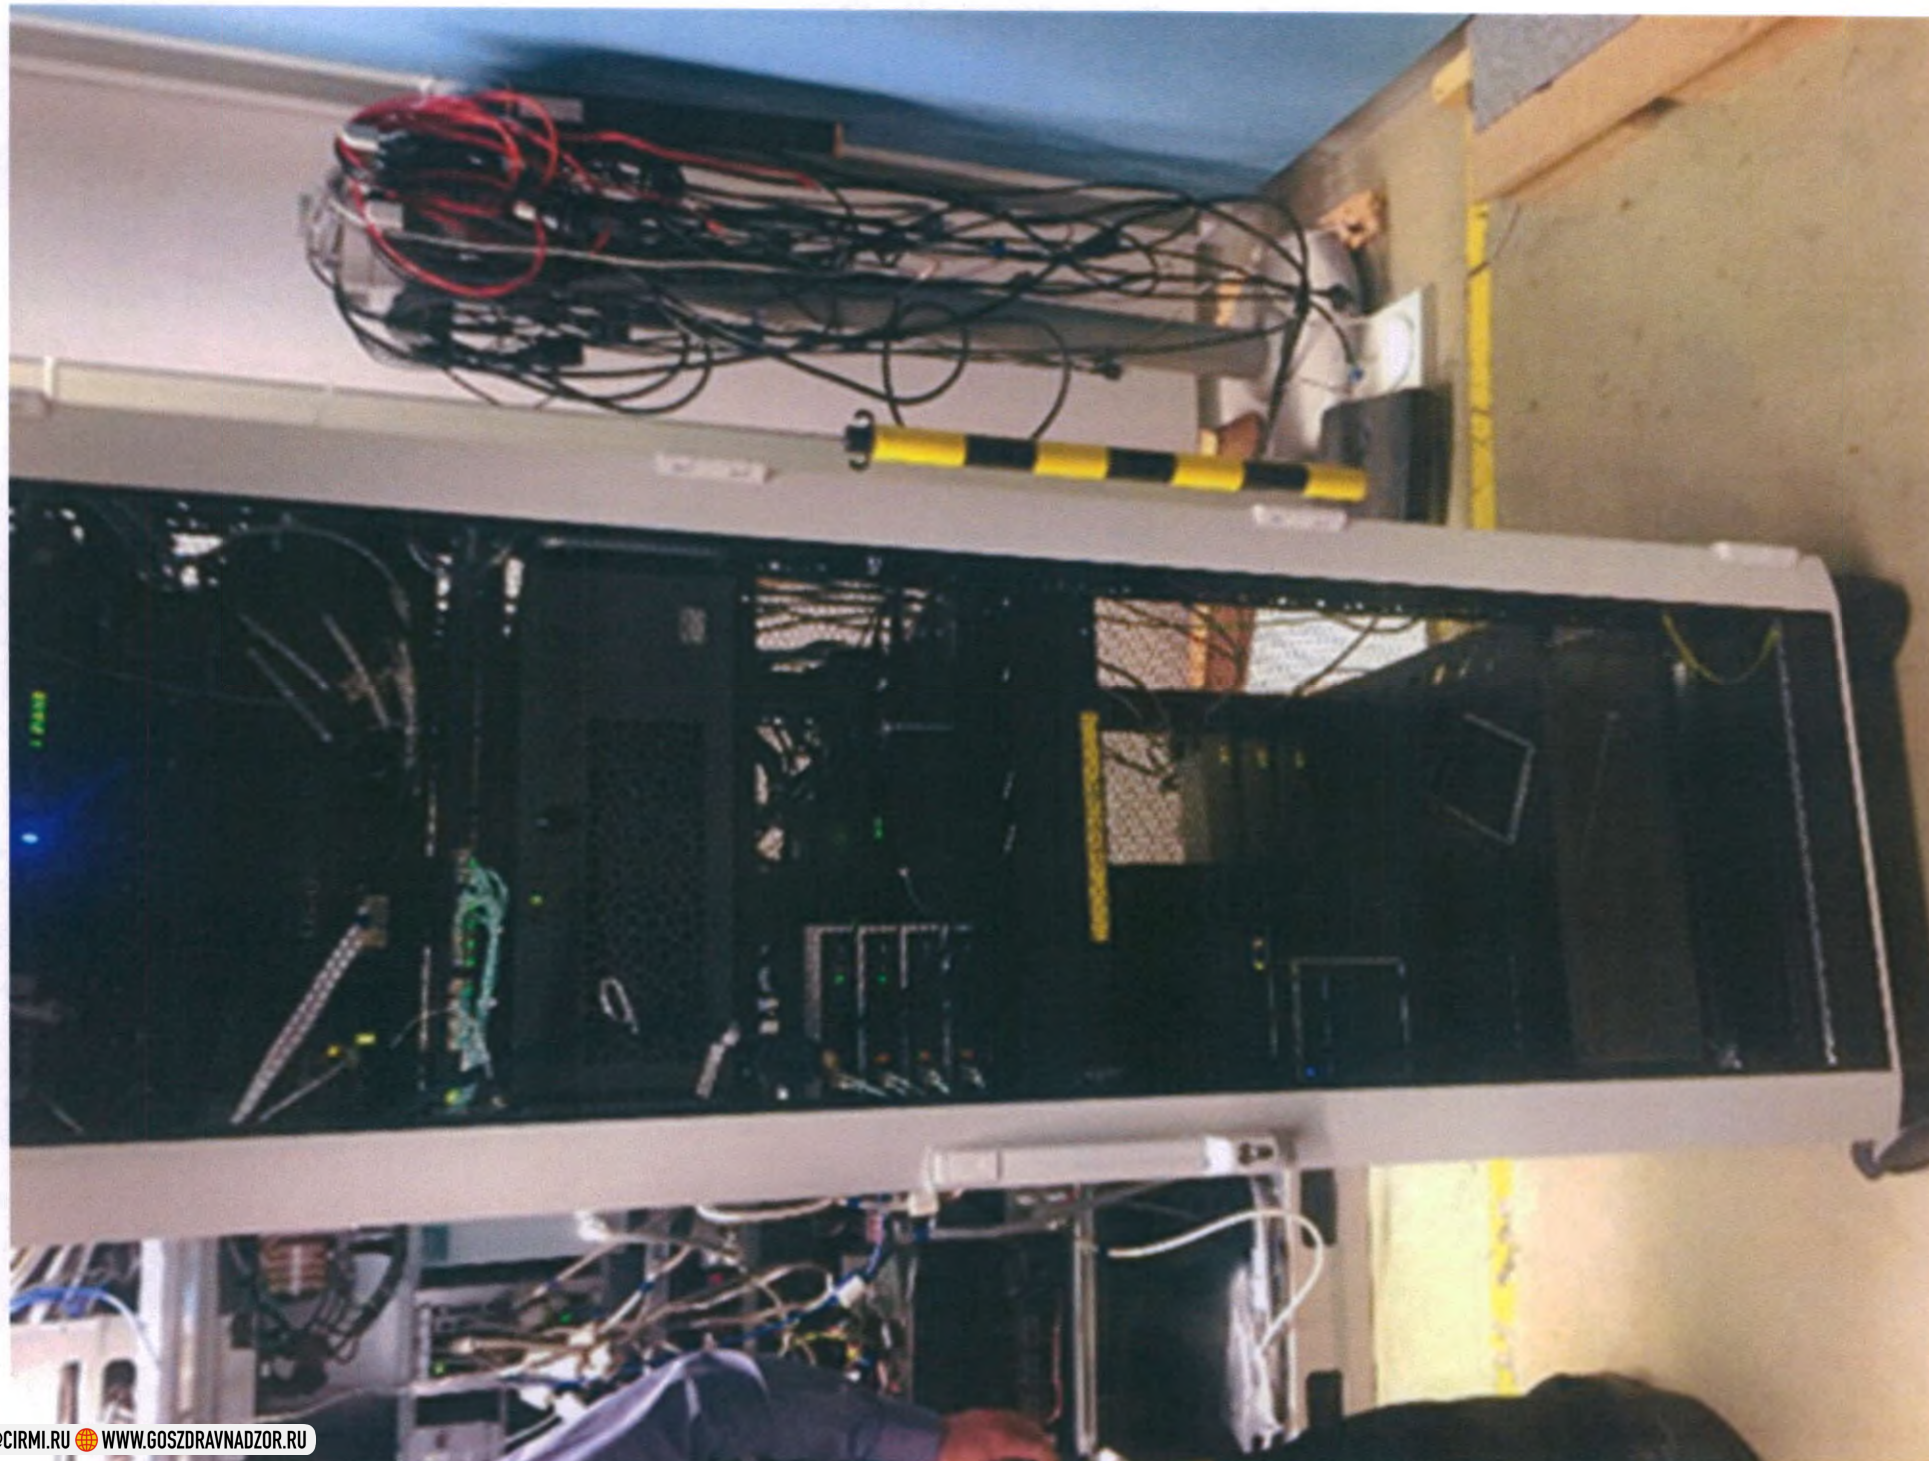


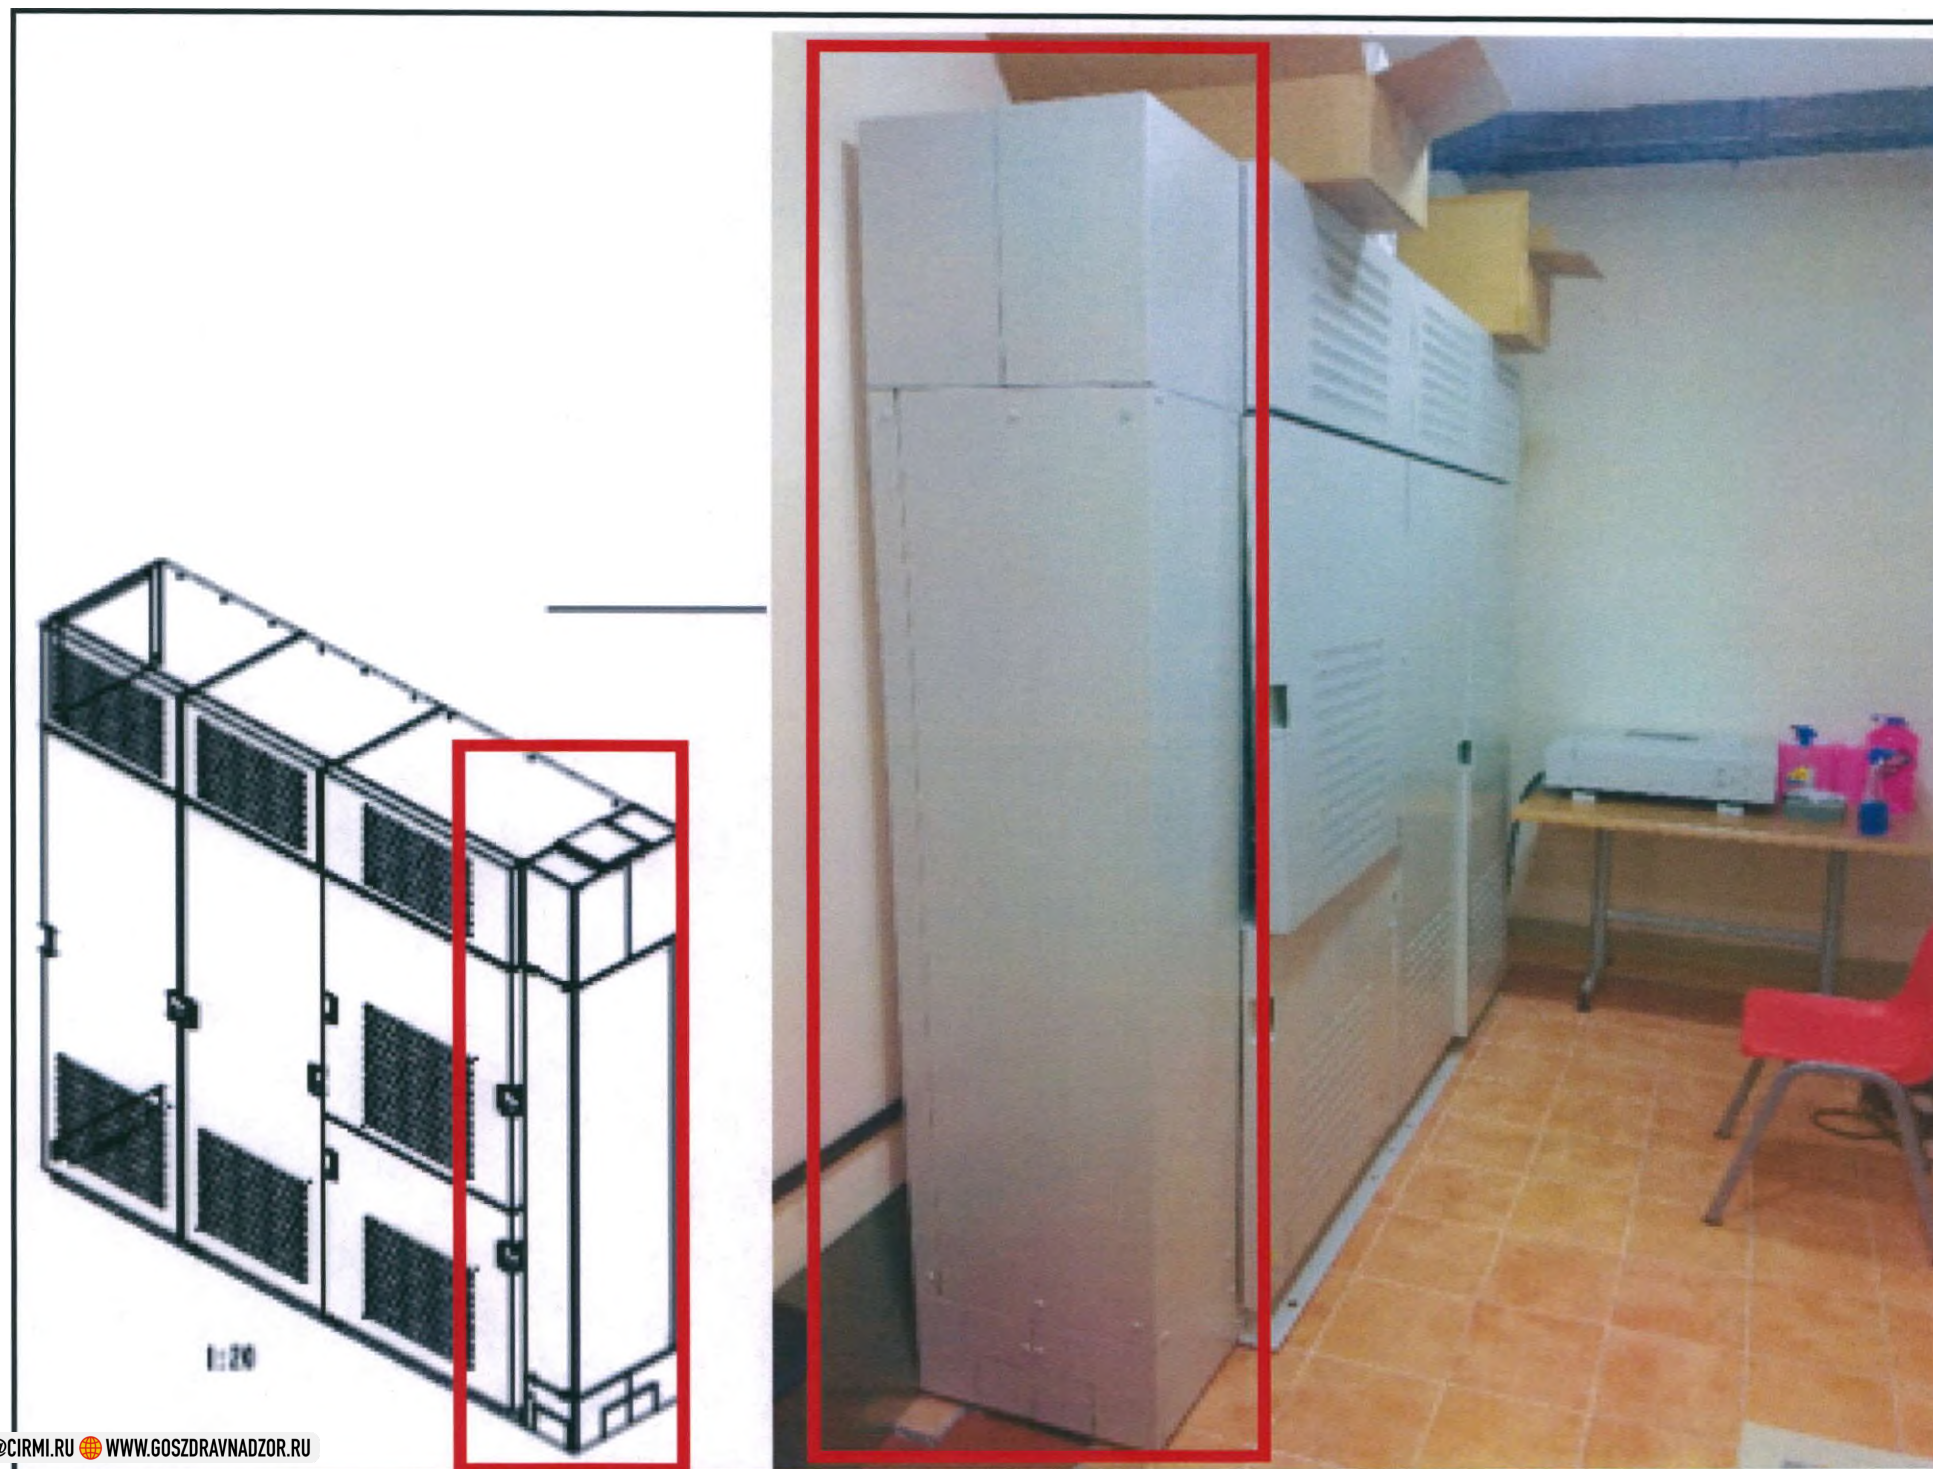




29. Комплект принадлежностей для ступенчатой ЦСА.




Шаговое устройство
встроено внутрь
CAT-850B/B1

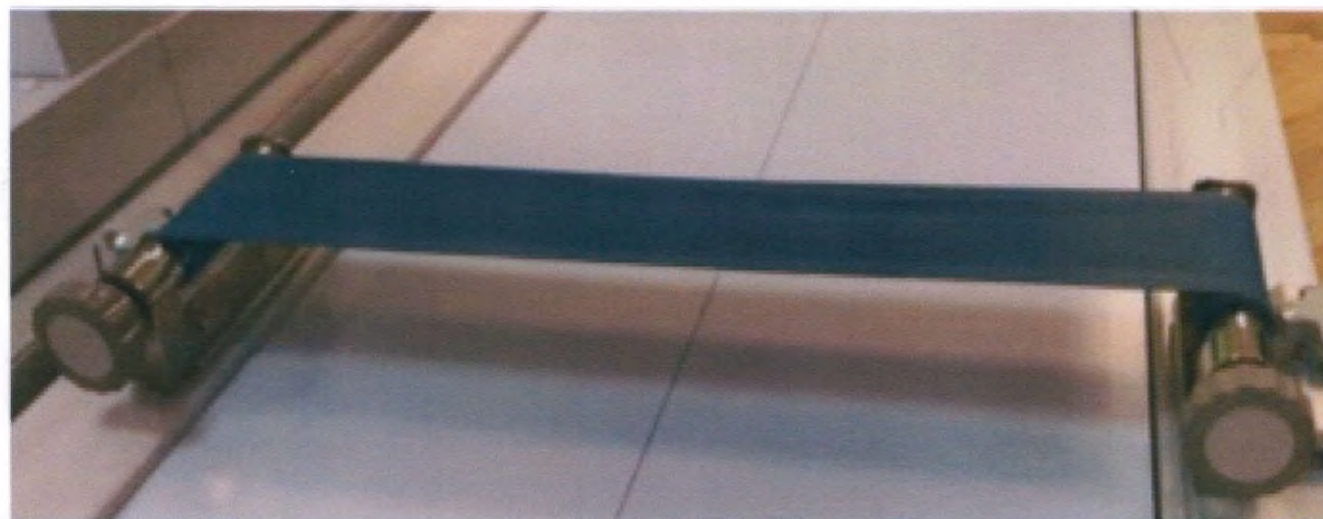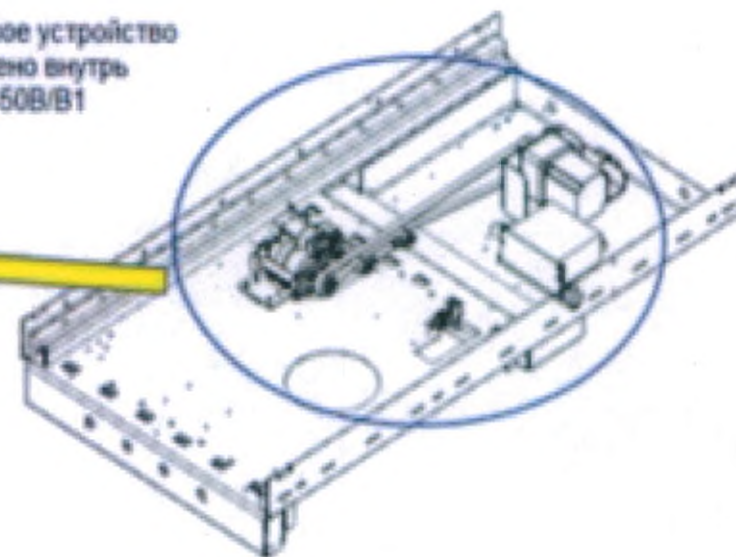



31. Модуль ротационной ЦСА.



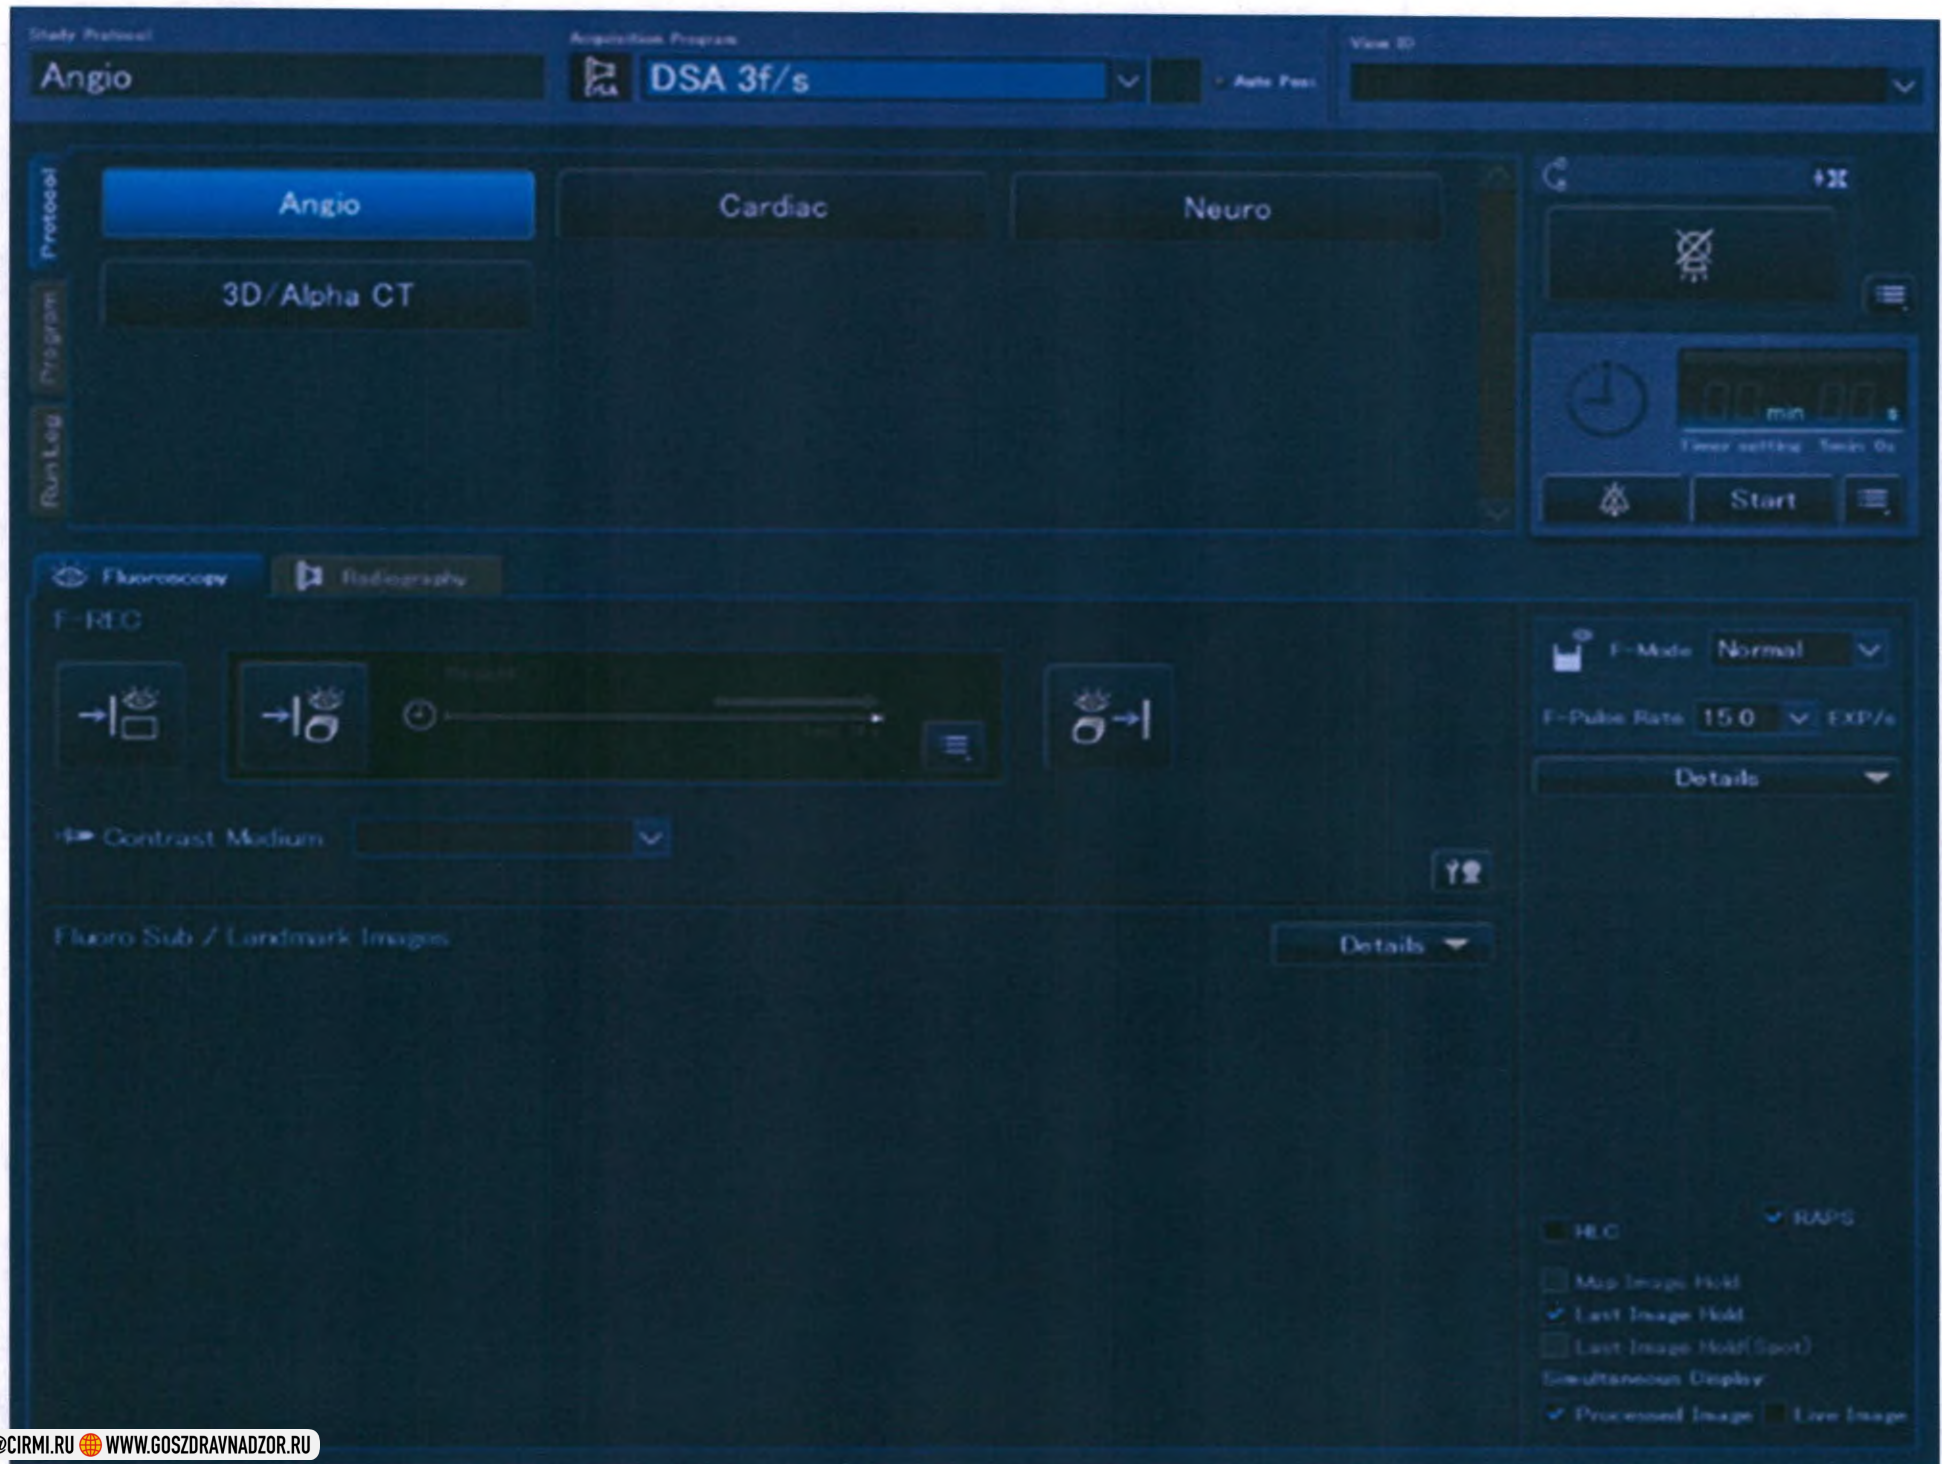

33. Модуль для низкоконтрастной визуализации (Alpha CT).

Study Protocol: 3D/Alpha CT Acquisition Program: CT Multi 5s 12" View 3D

Protocol Parameters

System Mode
☐ Cardiac ☒ Angio 1
☐ Sequential Navi

Transfer Favorite
 SystemParam1 SystemParam2

Fluoroscopy Radiography

Tube Voltage 75 kV Focus
 Tube Current 320 mA Gain 100
 Pulse Width 40.0 ms

Target Dose 0.88 μ Gy
 Details

Test Shot Advanced Presets AEC Param.

Contrast Medium Floor Rot (deg.) 0

Phase1 Phase2 Phase3

Exposure Time(s) 4.0 4.0 4.0
 Delay From Injection Start(s) 6.0 16.0 26.0
 Speed(deg./s) 50.0 Deg./Frames 1.0

Rate(f/s) 60.0 Frames 223 x 3

SID 120
 FOV 12.0
☒ FOV Linkage

Radiographic Range
 RAO 120 LAO 120
 CRA 0 CRA 0

Function *Quality
 Mode Vessel Size
 1 Bone&Vessel 512
 2 No Select 512


OK Cancel

Total Time(s) 30.0 No. of frames 669 Total Deg 120




35. Комплект для вывода внешнего сигнала.



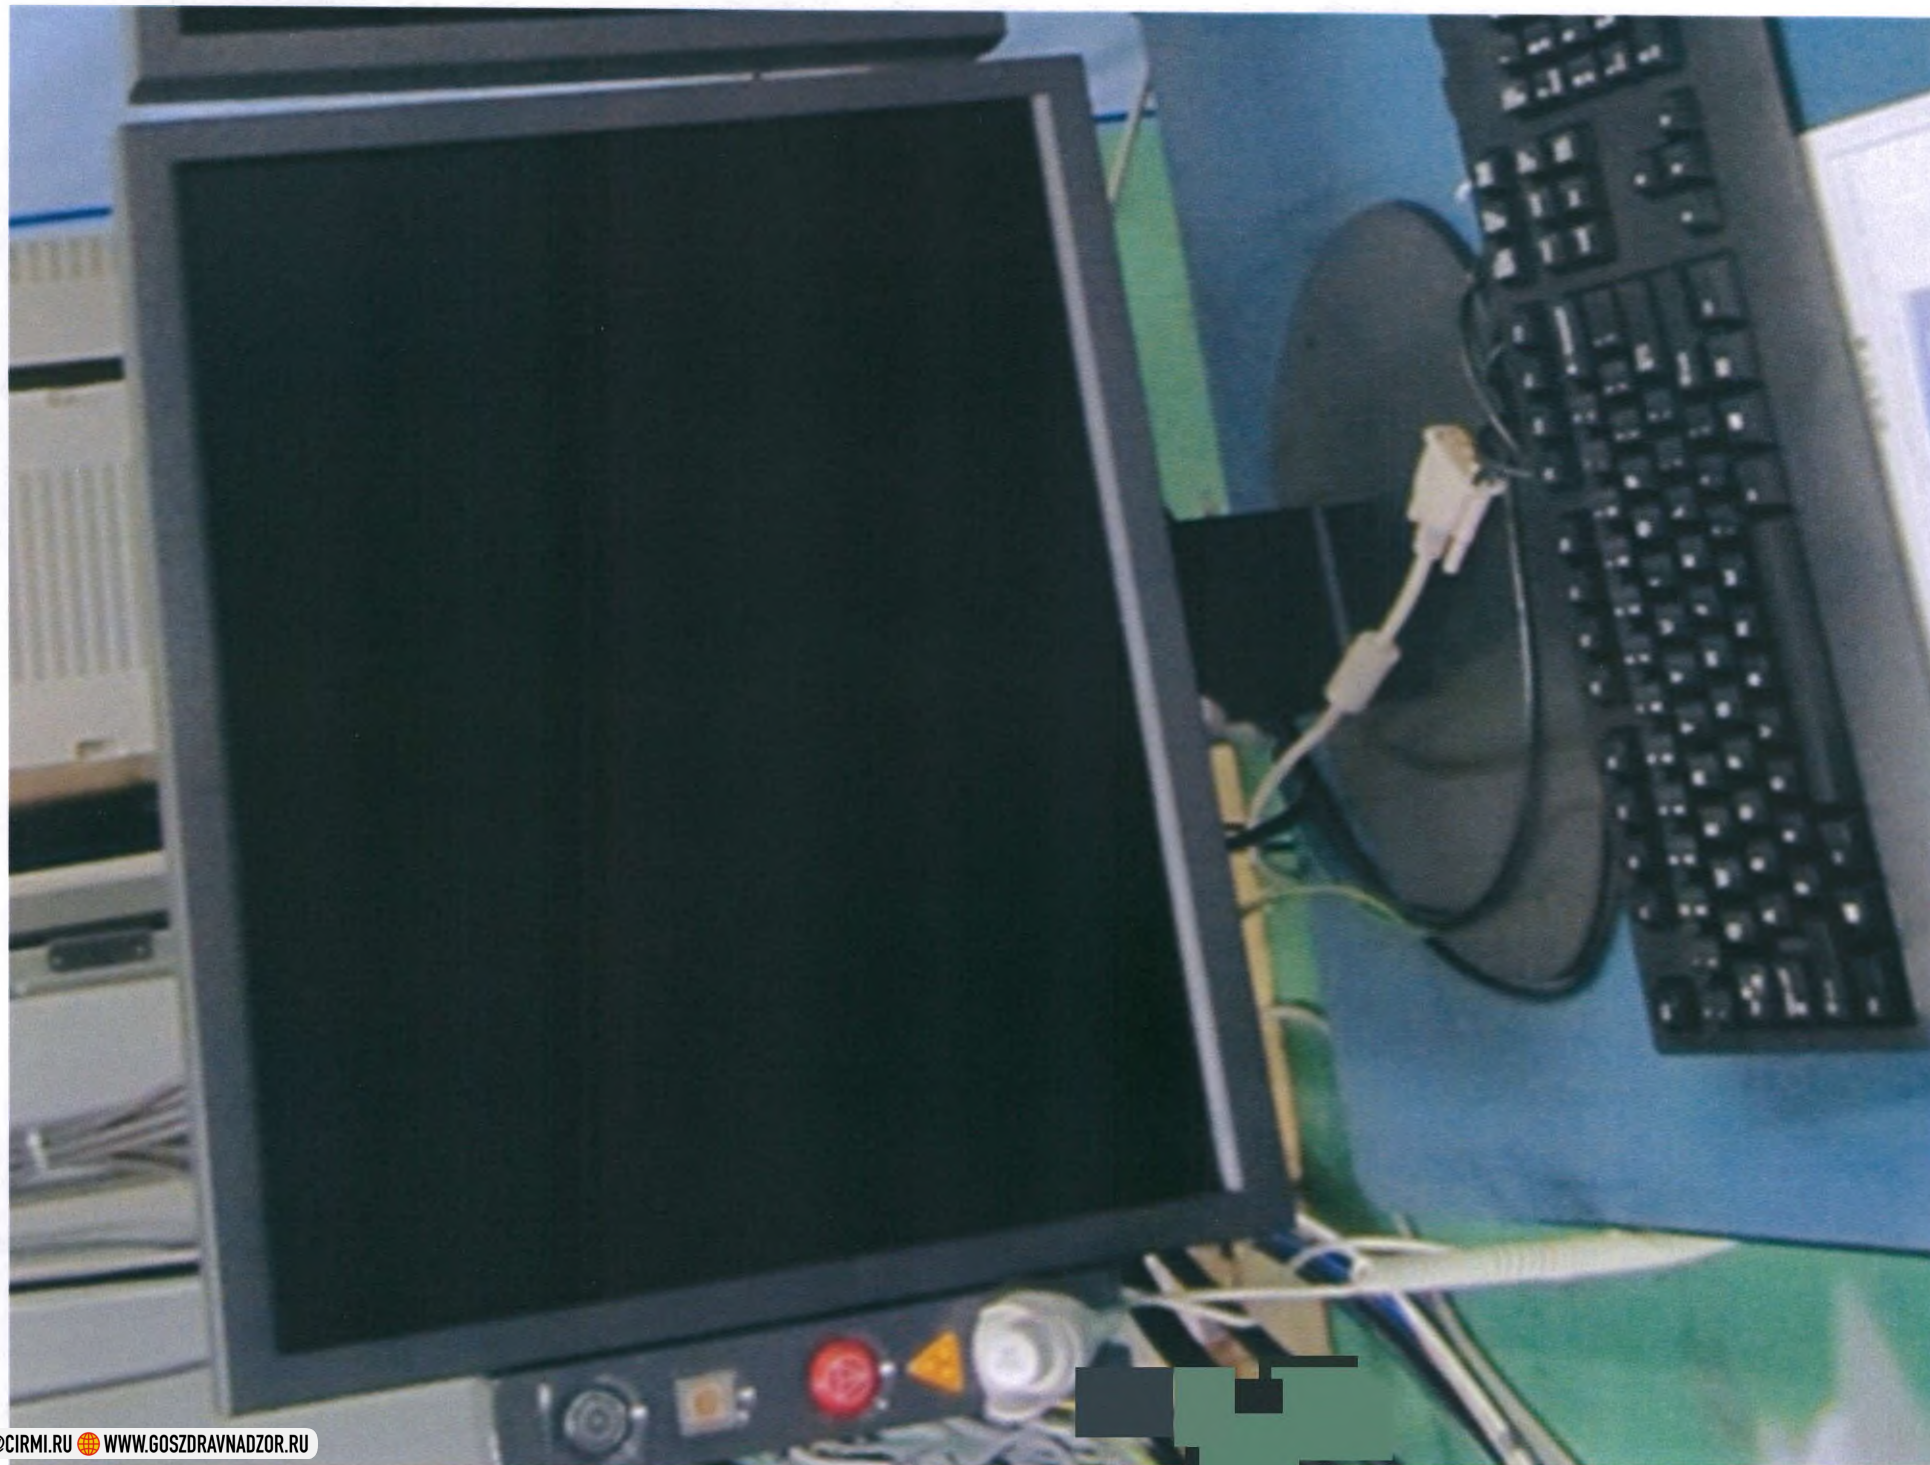



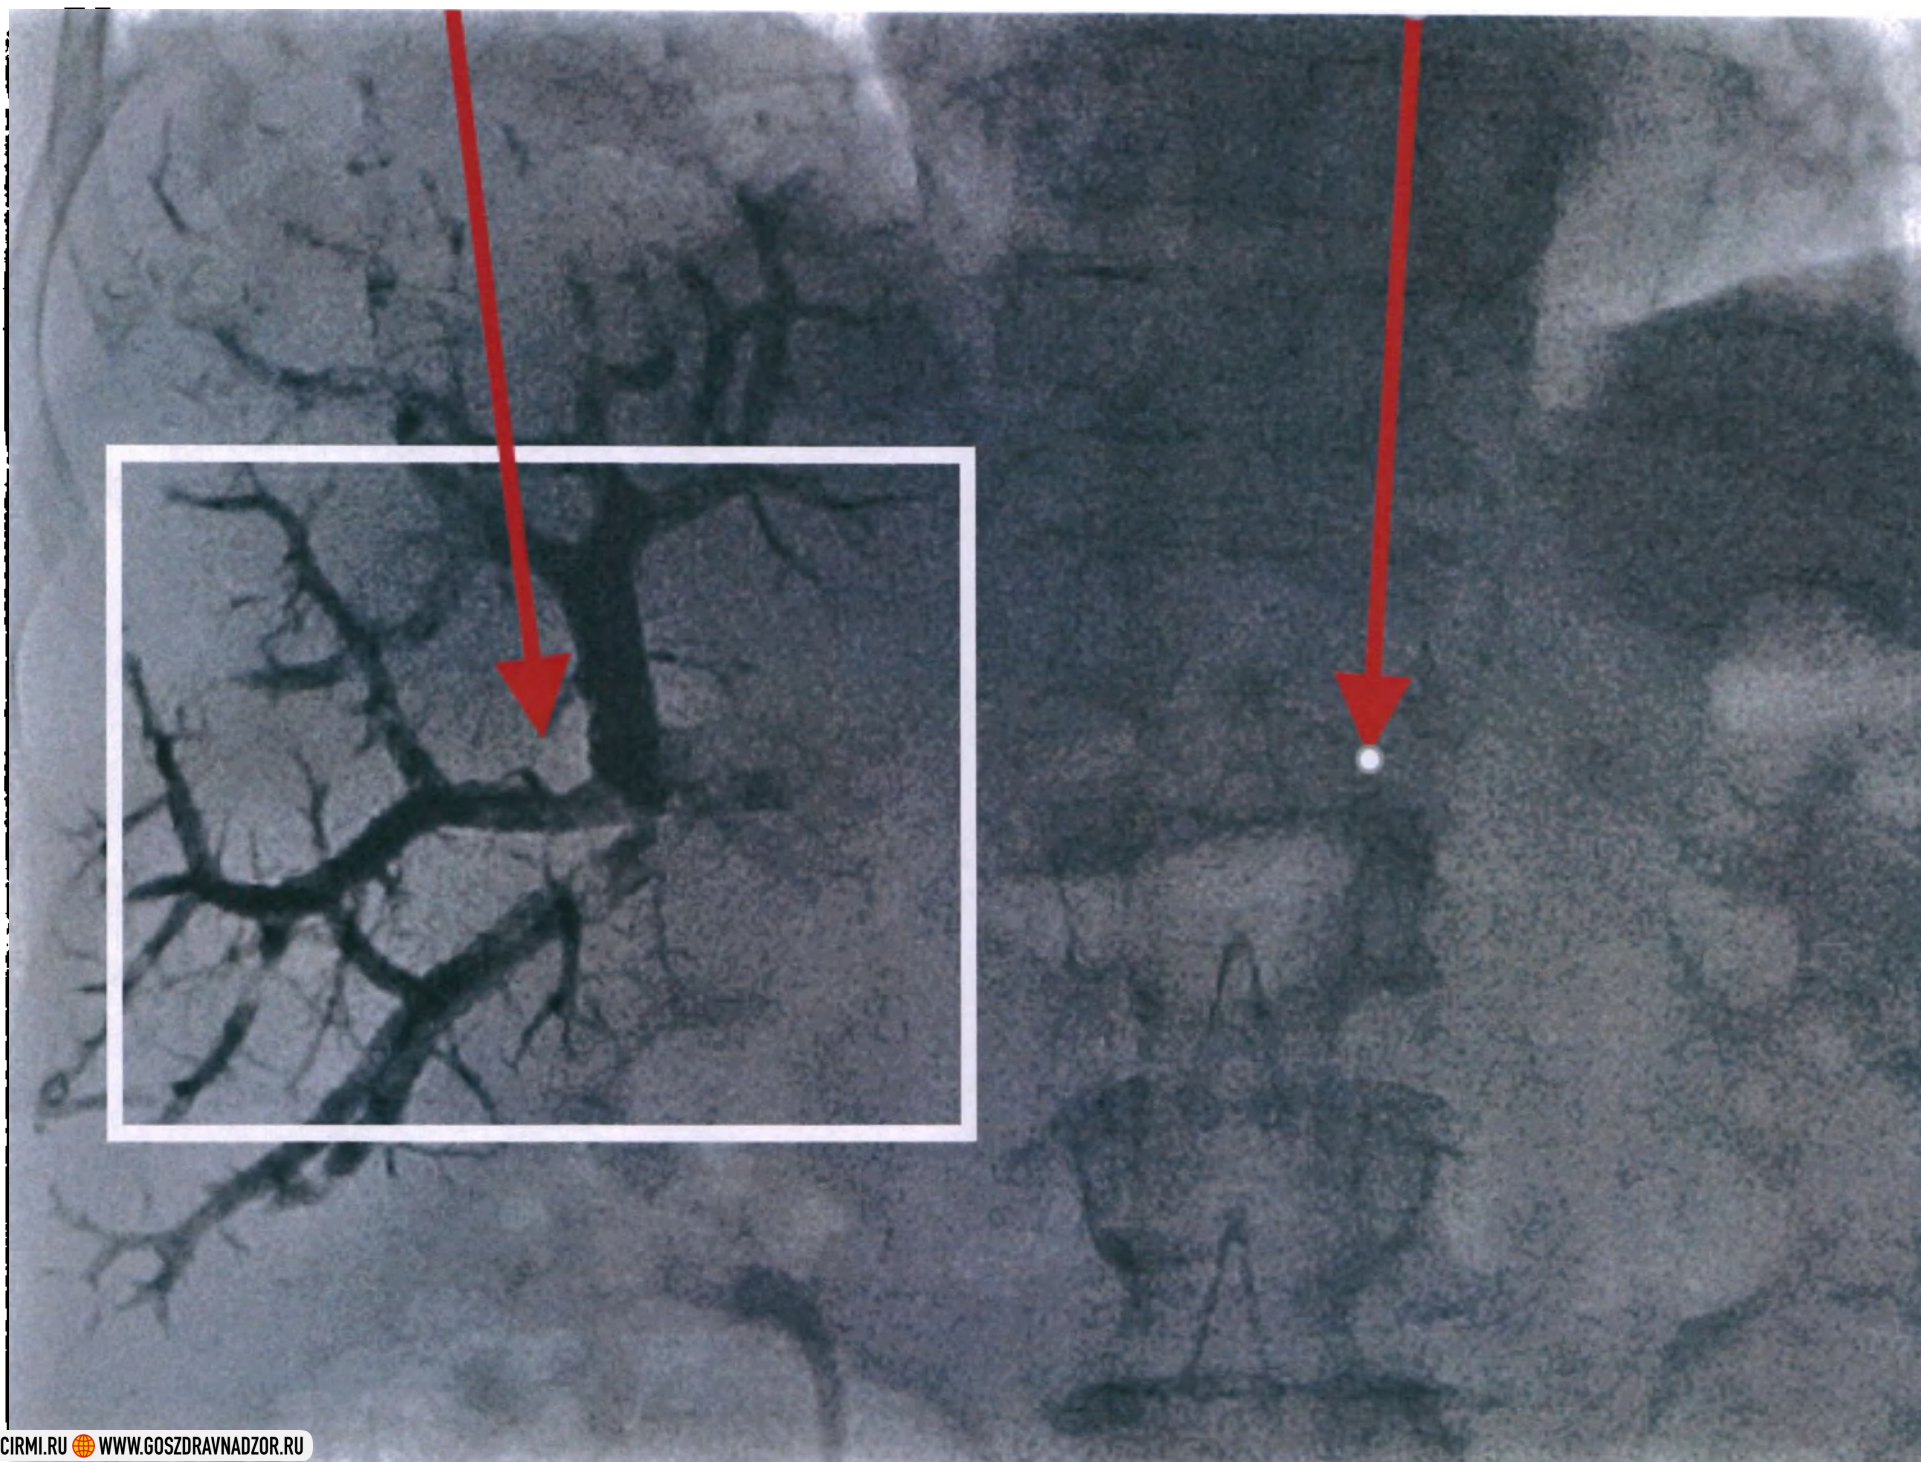

39. Монитор с большим экраном (для цифрового вывода, 48 портов).

034




Монитор



Многоэкранный сетевой компоновщик



Сенсорный интерфейс пользователя

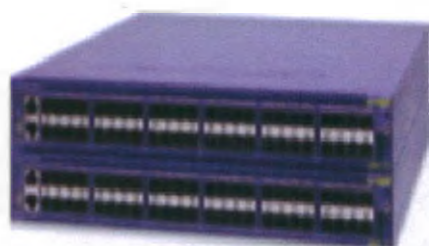

Коммутатор Summit x670-48x



Кодировщик MNA-120ENC-DVI





CAAS SETTINGS

CAL

LVA

RVA

QCA

QVA

About

Local Reference Method

☒ Mean local 1
 ☐ Mean local 2
 ☐ Interpolated

Default Analysis Method

Total Analyzed Segment

Local Diam Average Width

3

ITEM

Local Ref Average Width

3

ITEM

Maximum Diameter

50

☒ Snap Lesion At Local Minimum

Default


OK


Cancel









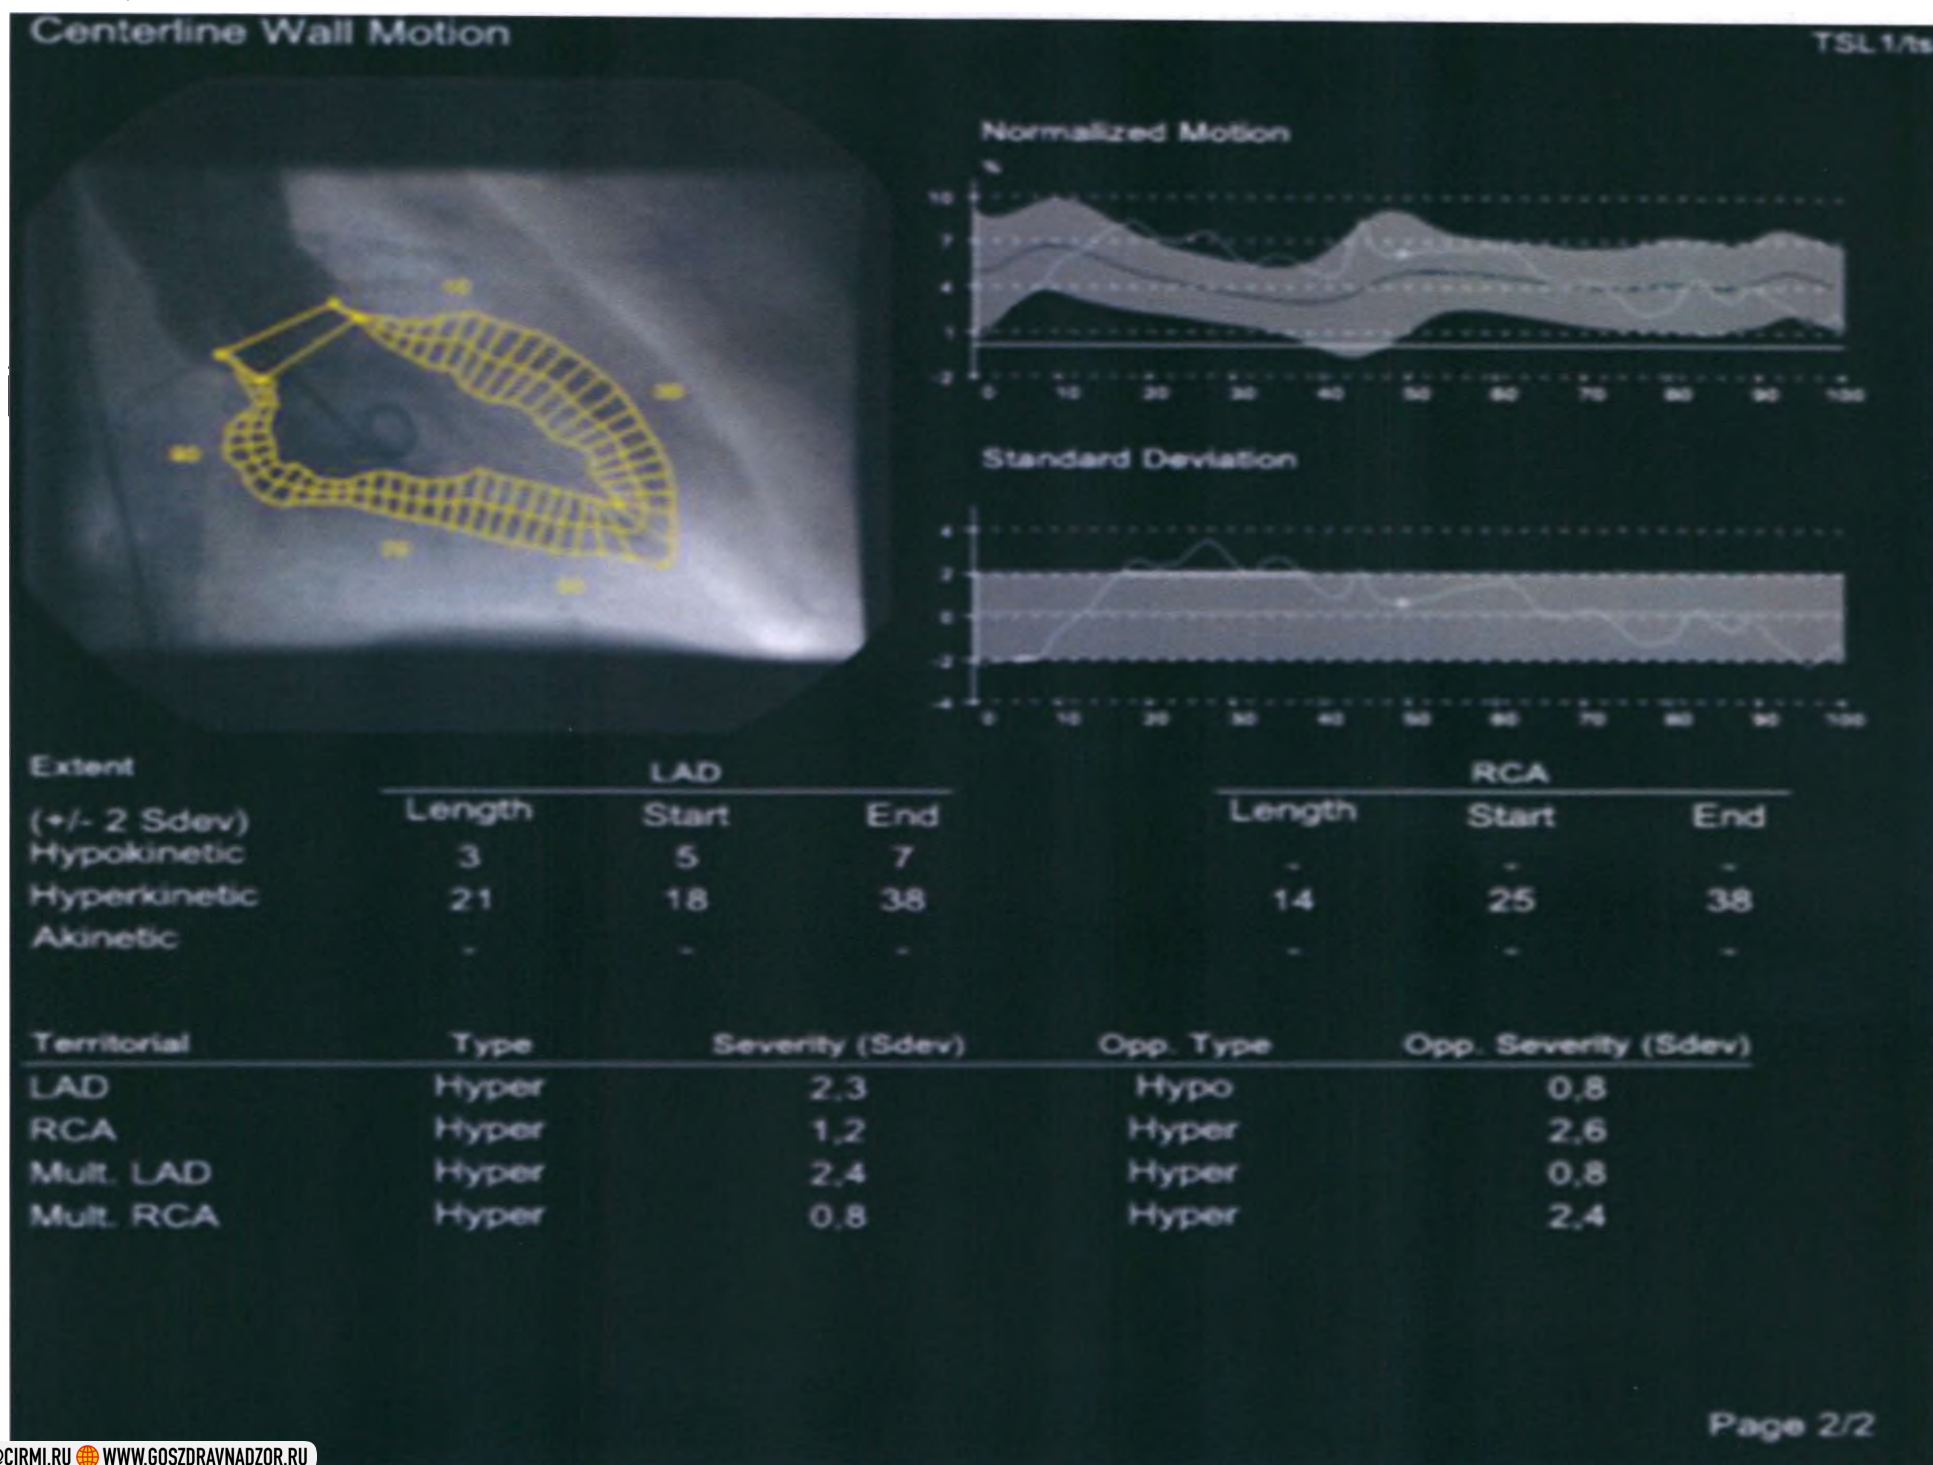


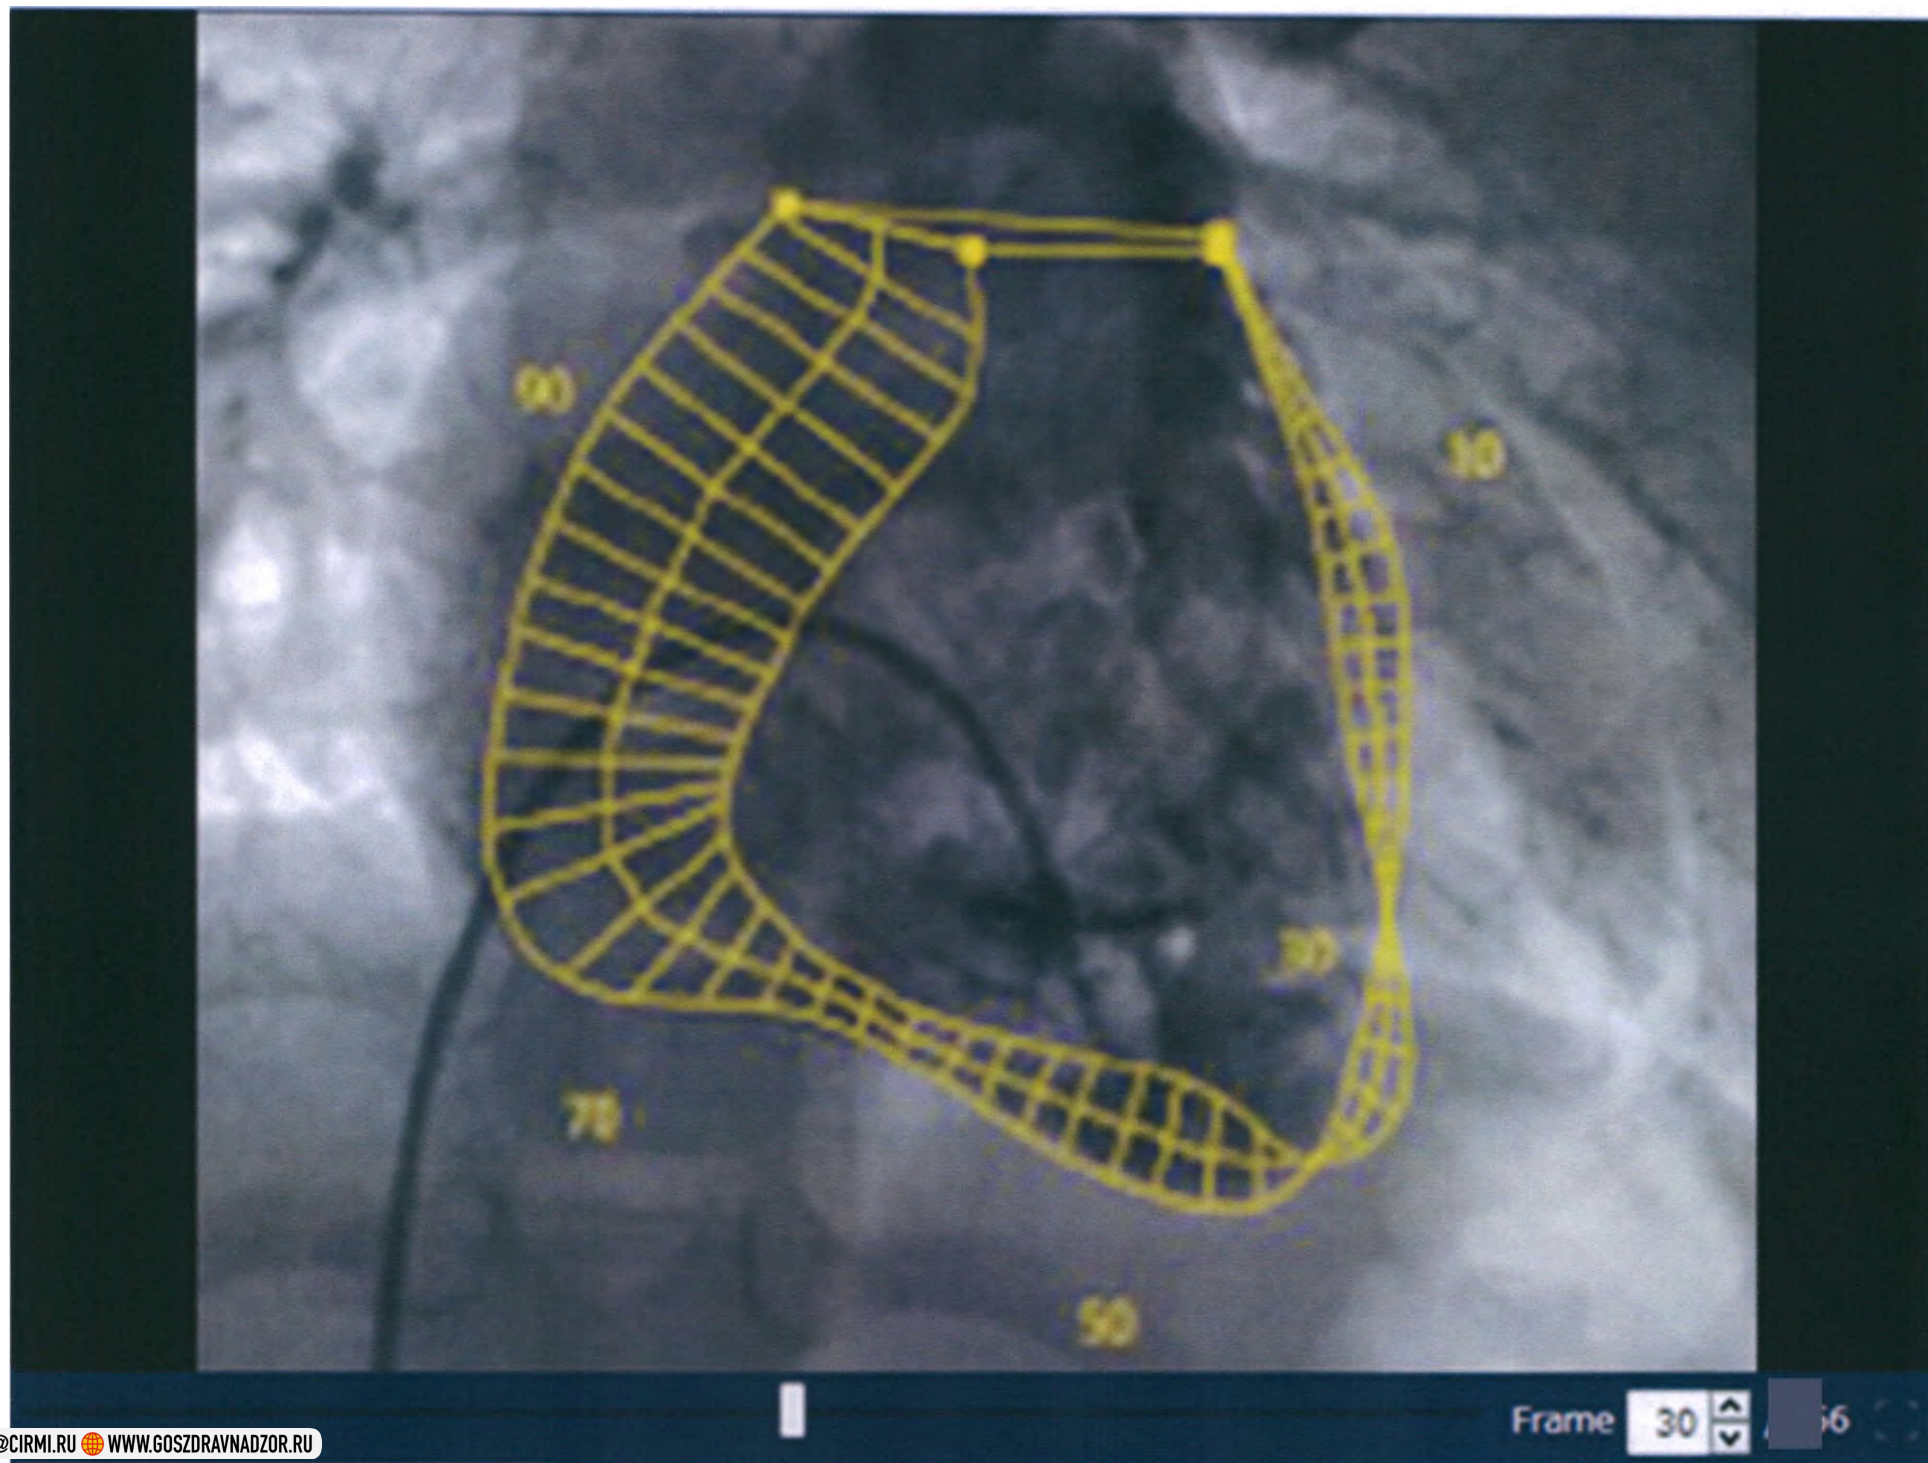

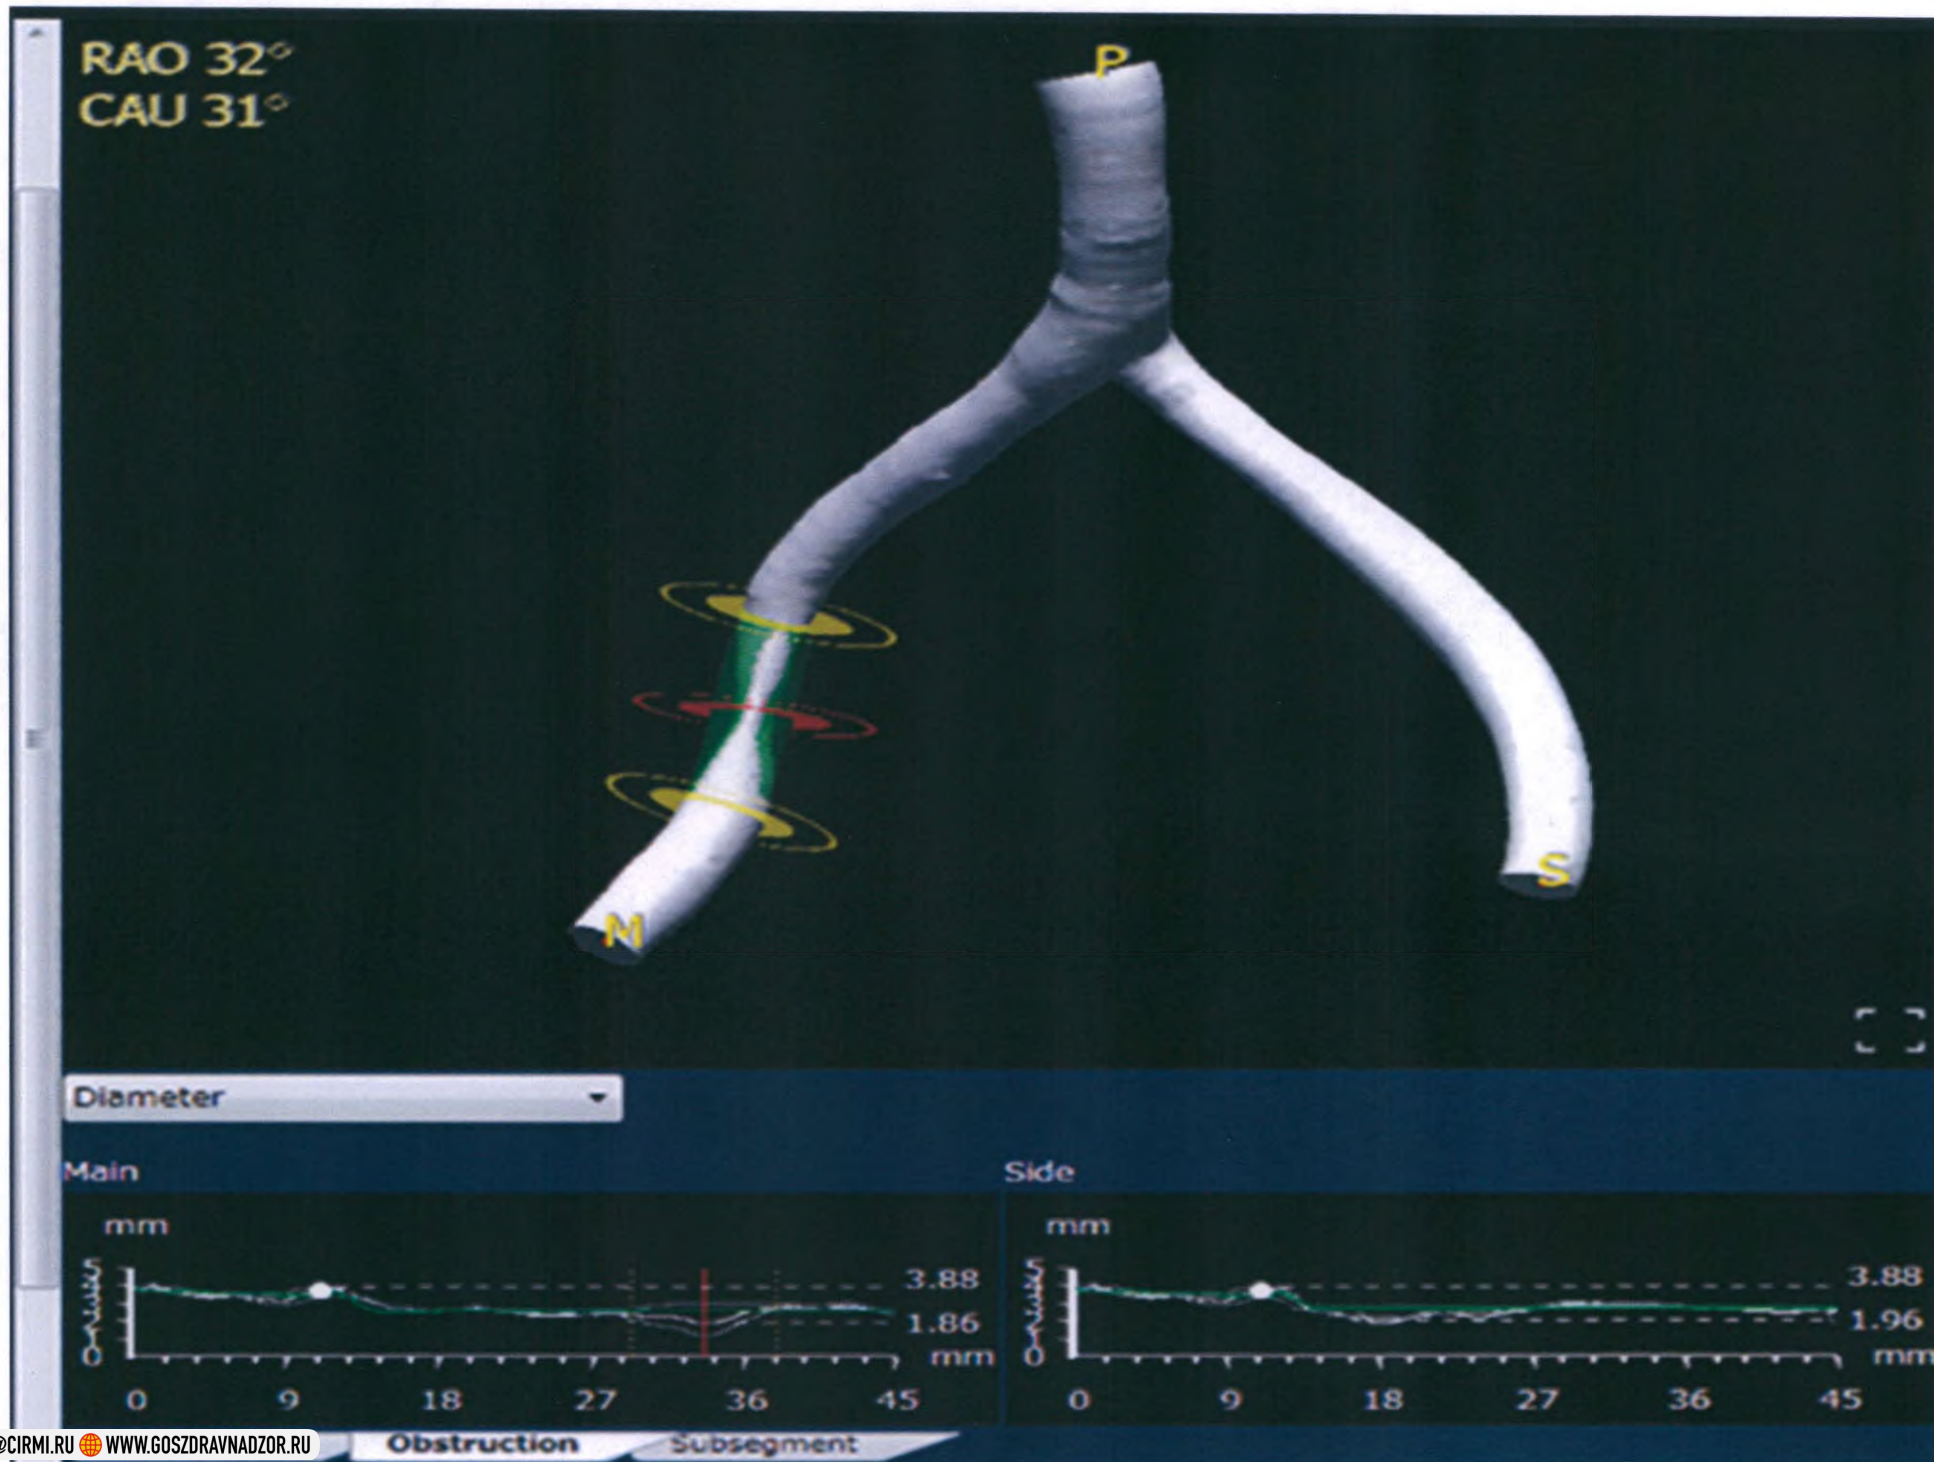


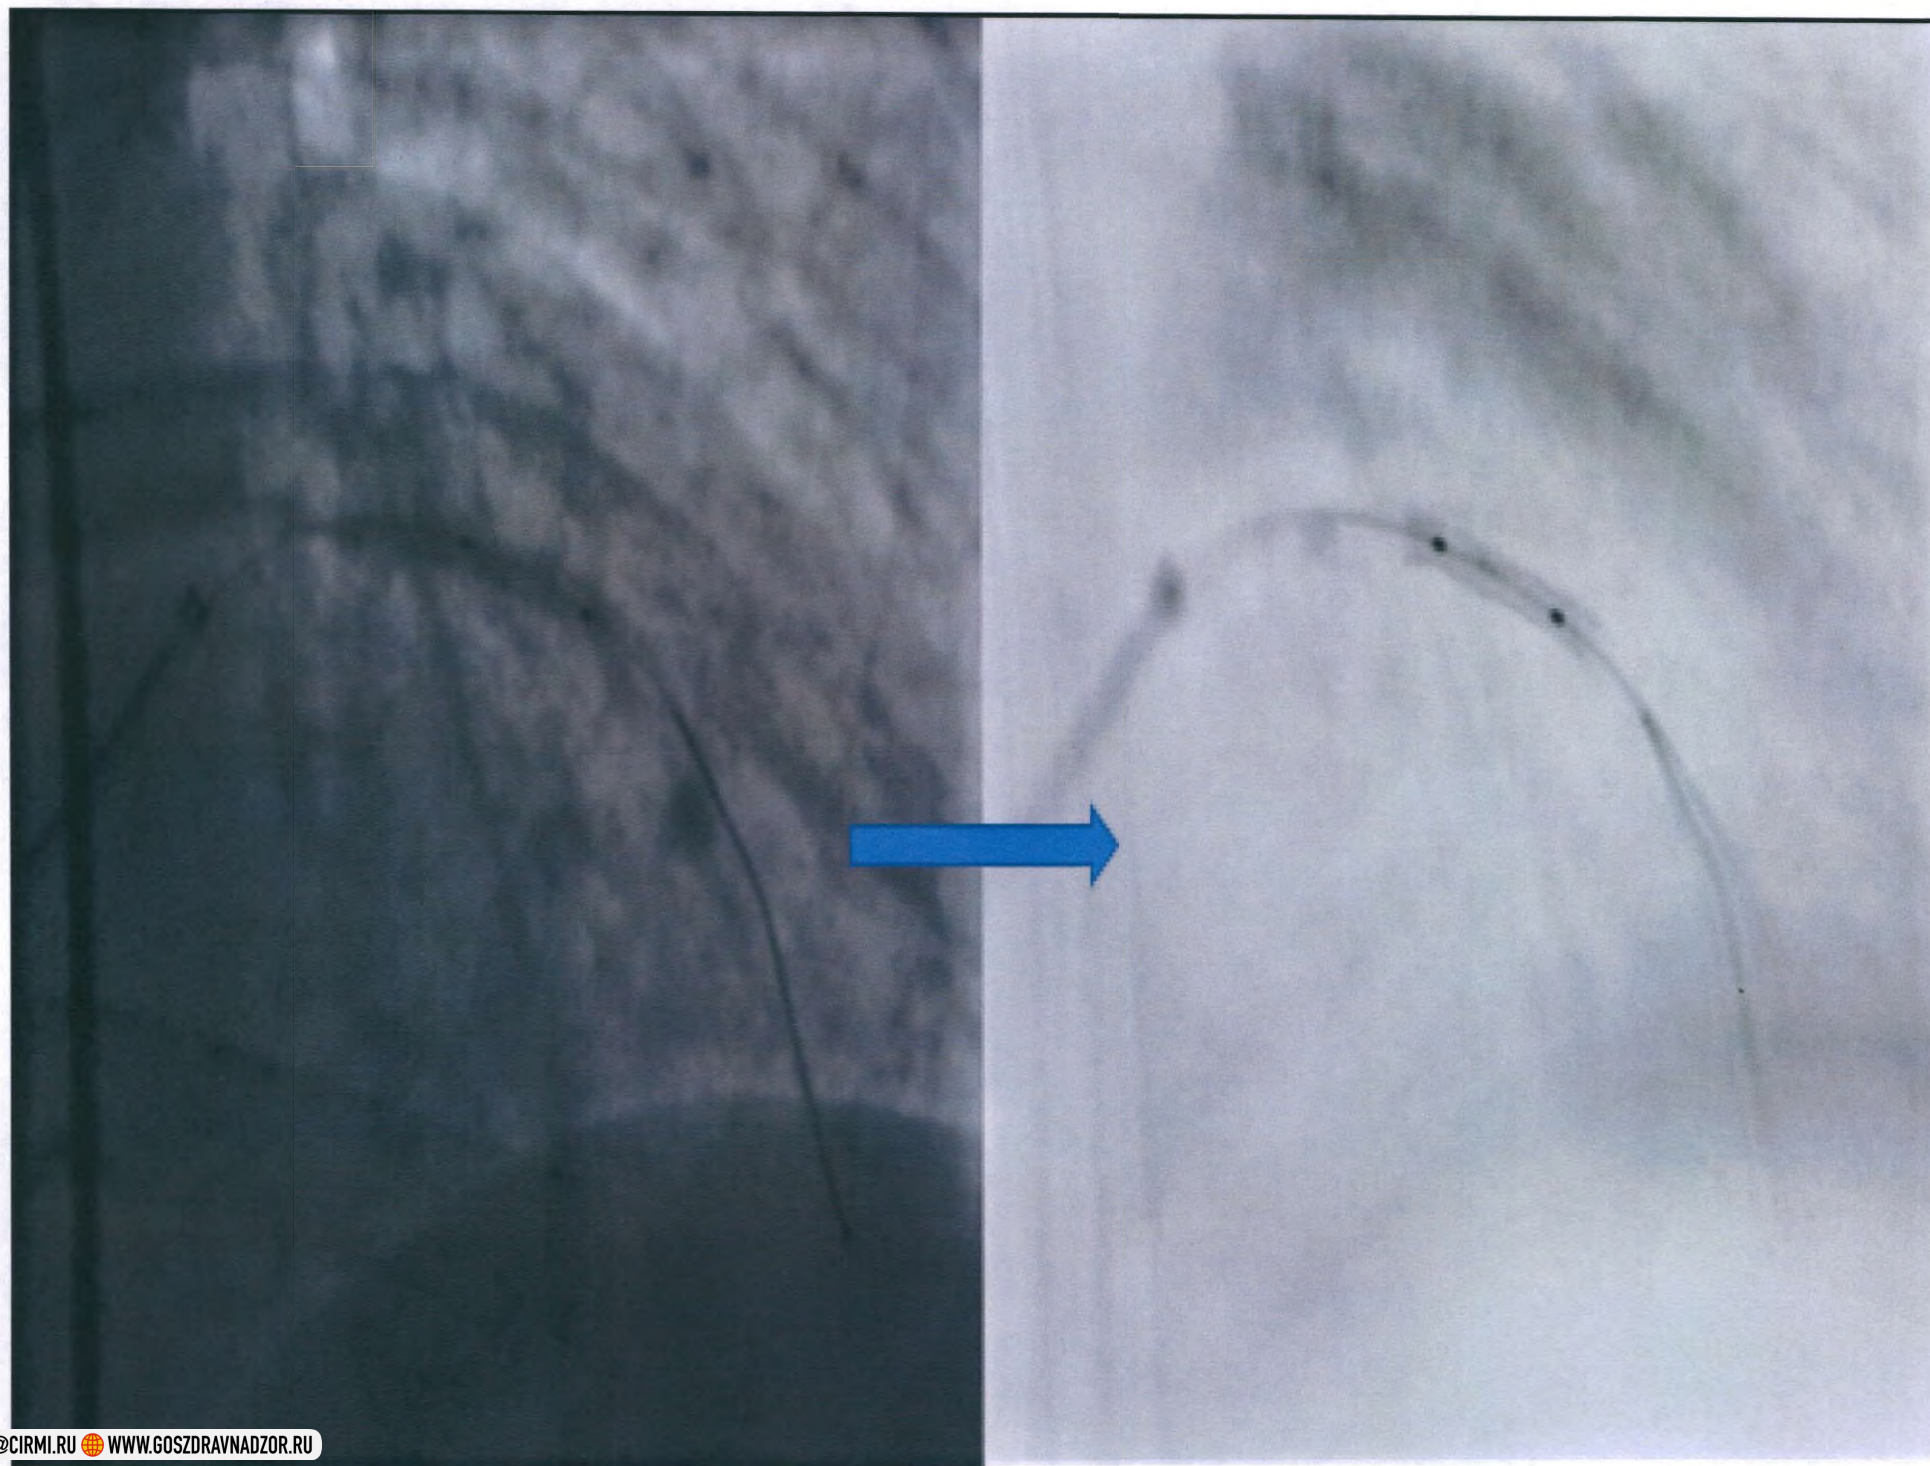

50. Монитор 19-дюймовый или монитор 34-дюймовый, не более 5 шт.

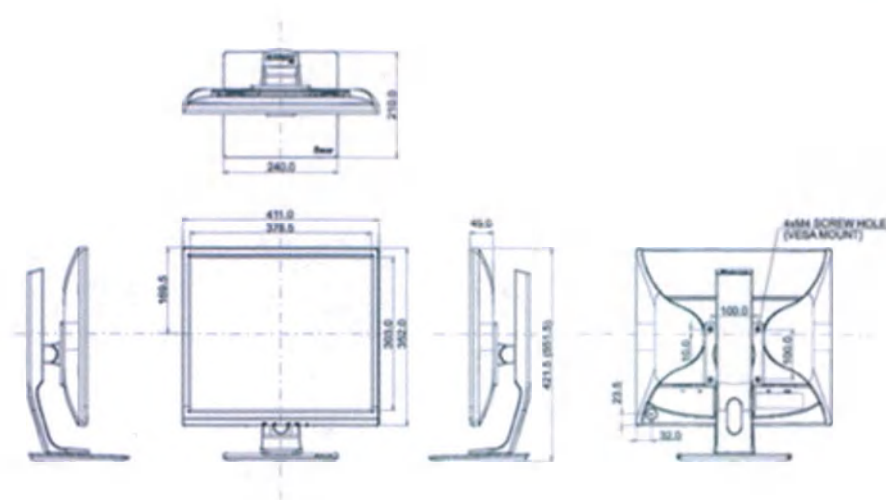


Модель монитора «IIYAMA Prolite», размер диагонали 19 дюймов

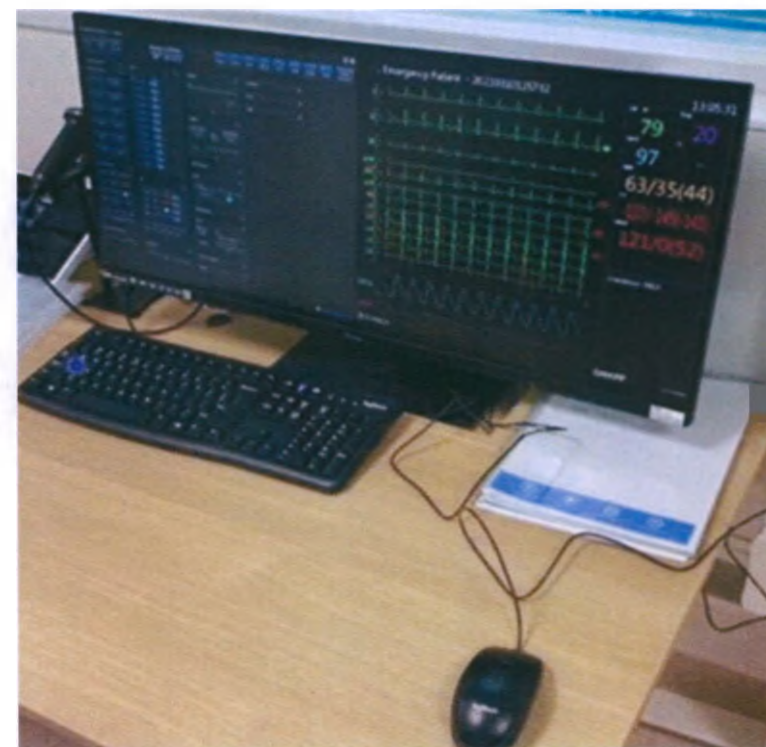

51. Принтер лазерный ч/б



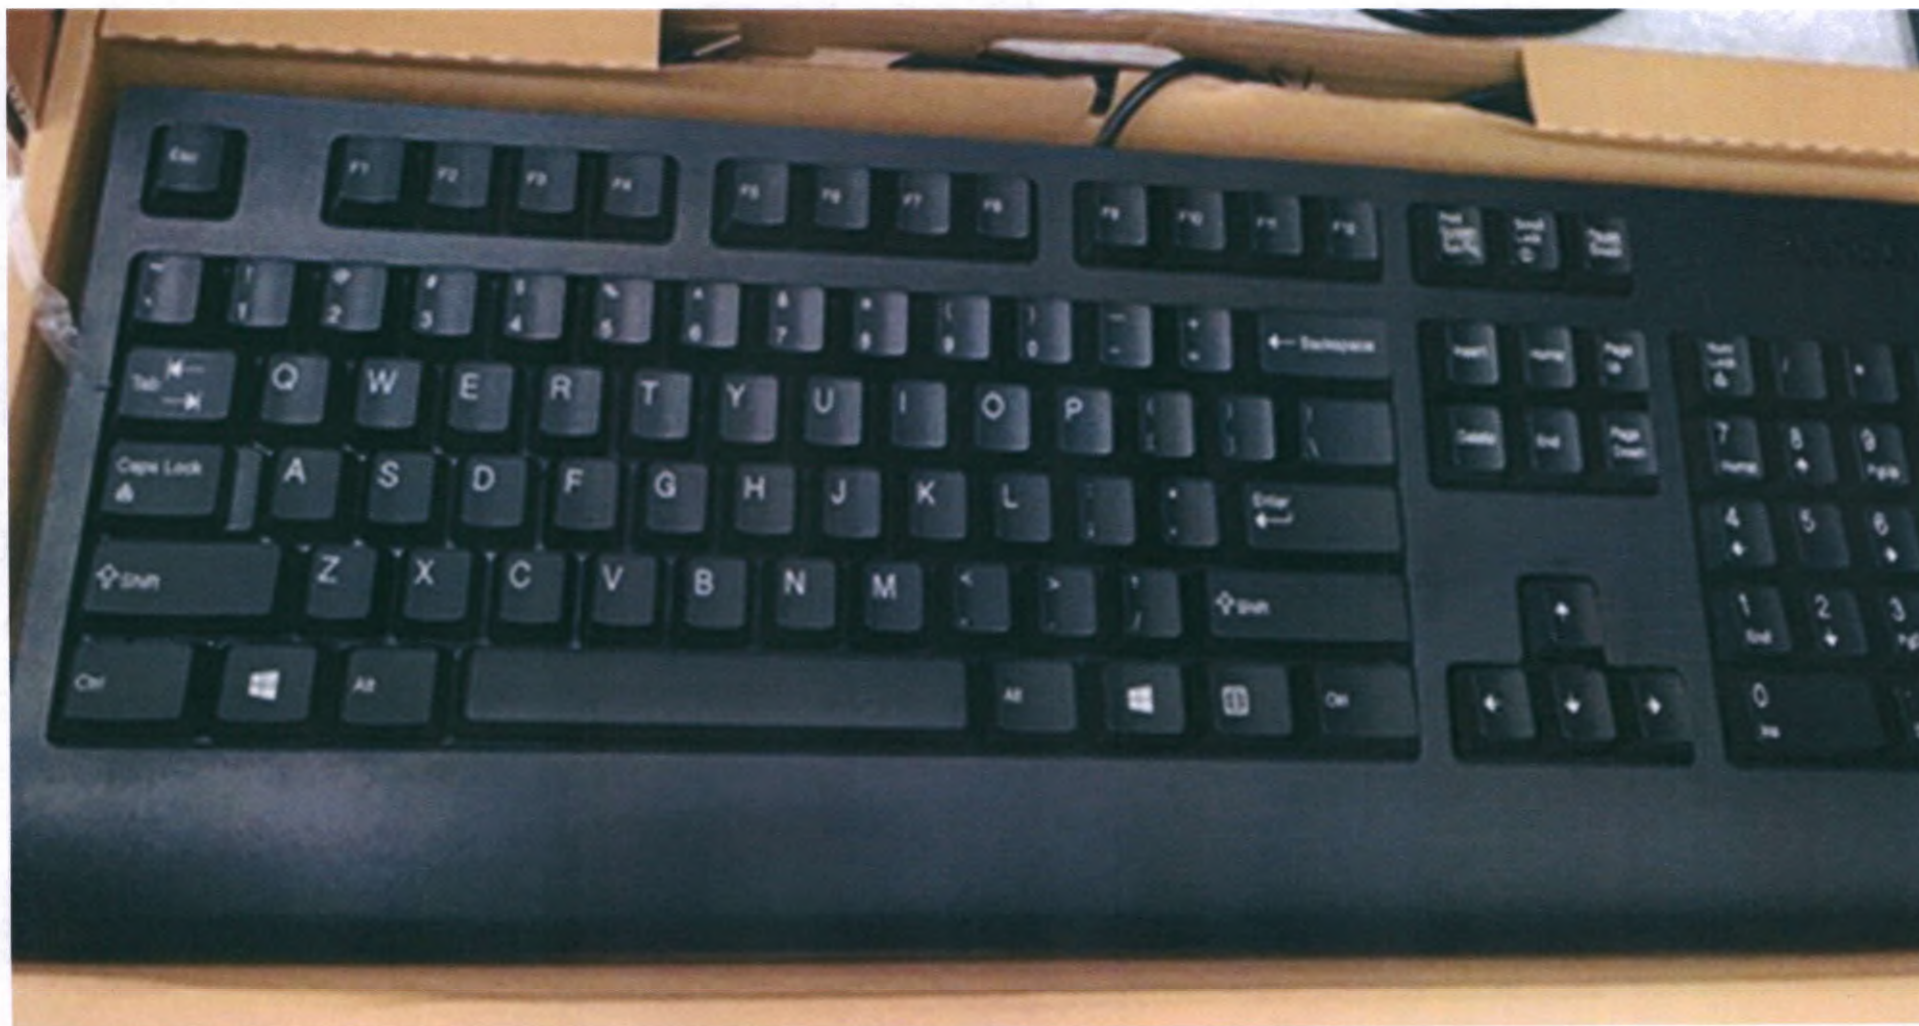





55. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.



Манжета многоразовая NIBP, детская (оранжевая), 8-13 см



Манжета многоразовая NIBP, детская (зеленая), 12-19 см



Манжета многоразовая NIBP, маленькая, для взрослых (ярко-синяя), 17-25 см



Манжета многоразовая NIBP, для взрослых (серая), 23-33 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (серая), 28-40 см



Манжета многоразовая NIBP, большая, для взрослых (бордовая), 40-55 см

55. Манжета для неинвазивного измерения давления, не более 12 шт.

001



Манжета многоцветная NIBP, бедренная (коричневая), 38-50 см

56. Кабель соединительный магистральный для ЭКГ, не более 6 шт.








Кабель для датчика инвазивного измерения давления, длина 320 см



Красный коннектор кабеля-удлинителя ИВР к разъему с надписью ИВР на усилителе QMAPP.

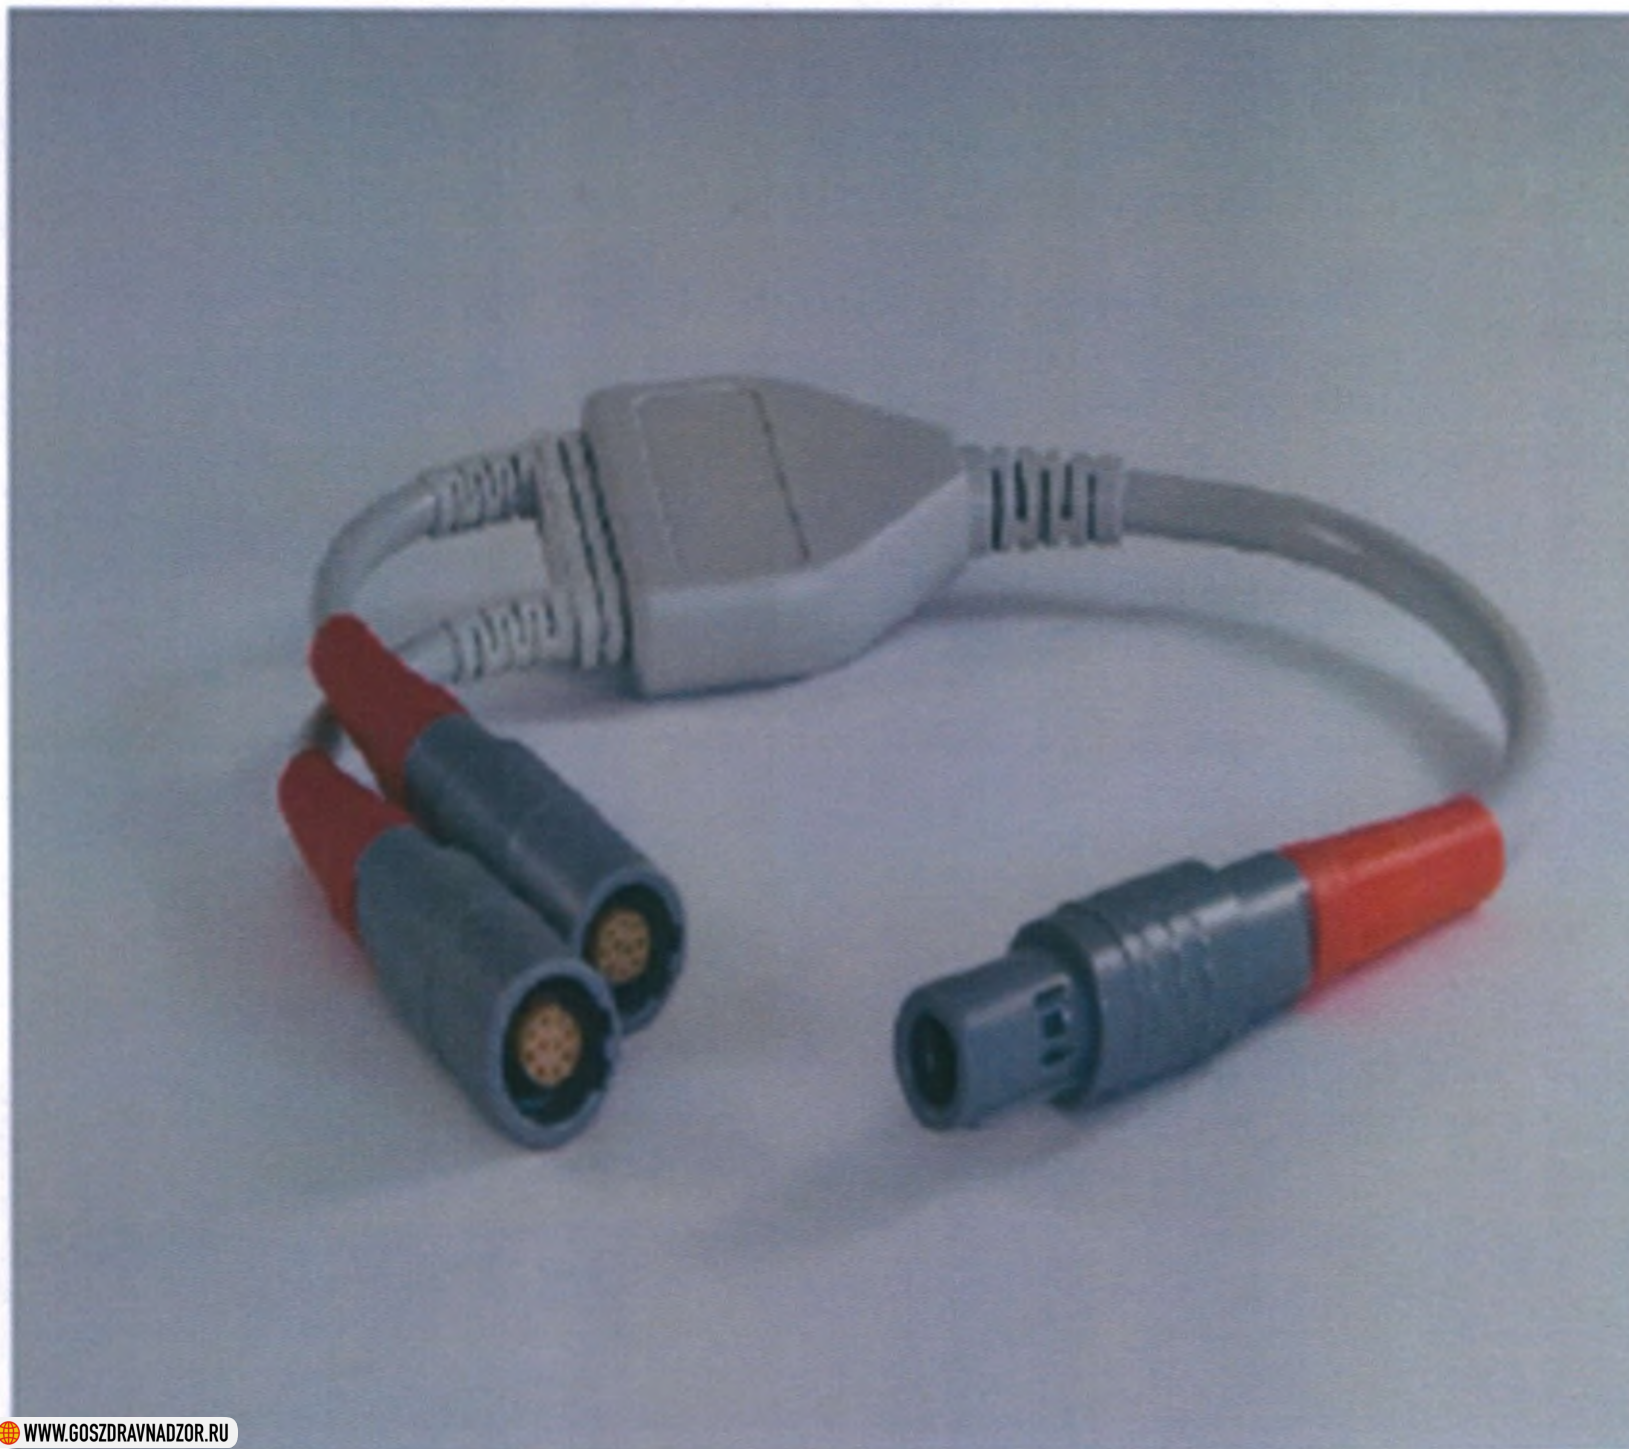




61. Кабель соединительный для модуля ИВР, не более 6 шт.





63. Модуль измерения сердечного выброса методом термоделиции

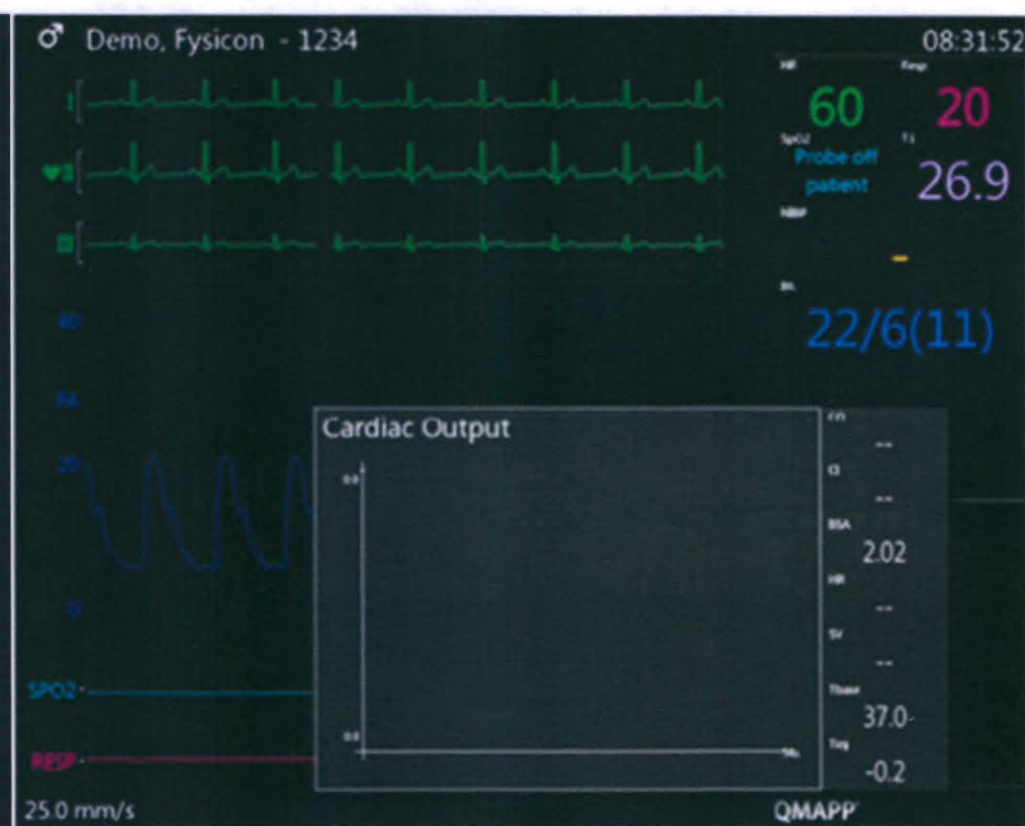

64. Комплект для измерения сердечного выброса методом термоделюции, в составе:- кабель для измерения сердечного выброса методом термоделюции, не более 2 шт.;



64. Комплект для измерения сердечного выброса методом термоделиции, в составе:

- датчик для измерения сердечного выброса методом термоделиции, не более 2 шт.



65. Модуль для регистрации фракционного резерва кровотока.

FFR 

Mode: Monitoring

Channel:

Pa
(AO pressure)

Pd
(AOPd pressure wire)

Averaging: Short

Equalize

Record FFR

FFR 

Mode: Measurement

Channel:

Pa
(AO pressure)

Pd
(AOPd pressure wire)

Averaging: Middle

Equalize

Record FFR

66. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.



Кабель типа 6.3 мм «Моно Jack» для
«Volcano i5», длина 320 см



Кабель для регистрации давления для
«Volcano», длина 320 см




Кабель для регистрации давления Pa Pb
для «Boston Scientific», длина 320 см:



Кабель для регистрации давления Pa Pb
для «Boston Scientific», длина 320 см:

Кабель Pd к Boston

66. Кабель соединительный для регистрации фракционного резерва кровотока.

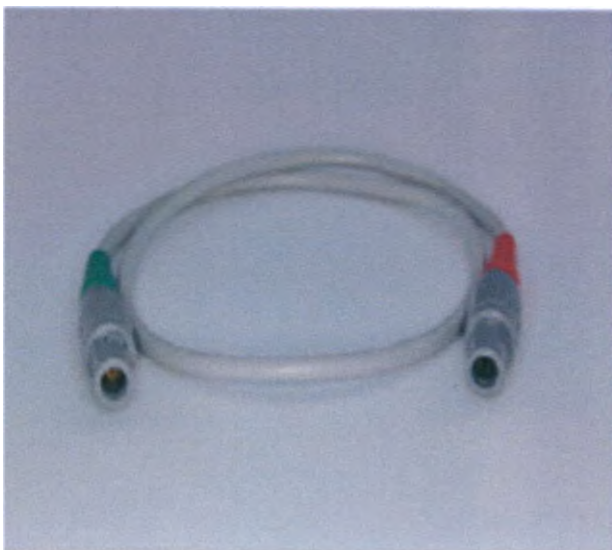

кабель Abbot длиной 65 см





кабель Abbot длиной 320 см




кабель для Abbot Wibox длиной 320 см


67. Блок для регистрации фракционного резерва кровотока

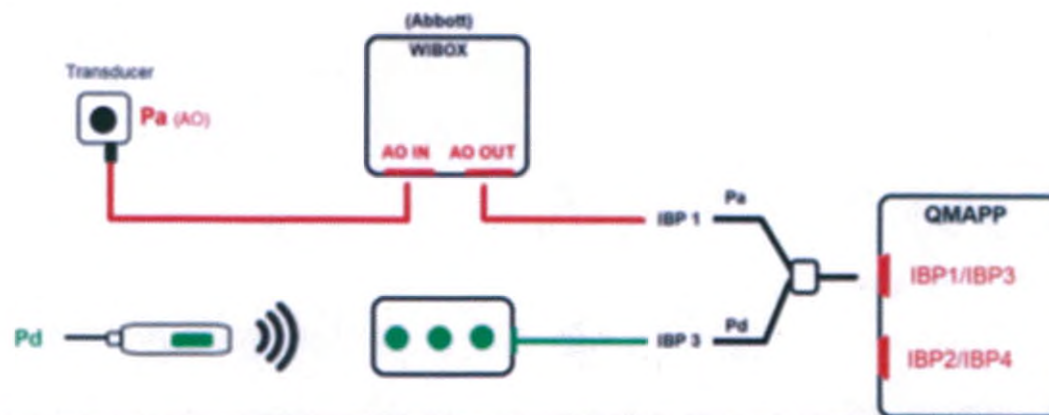


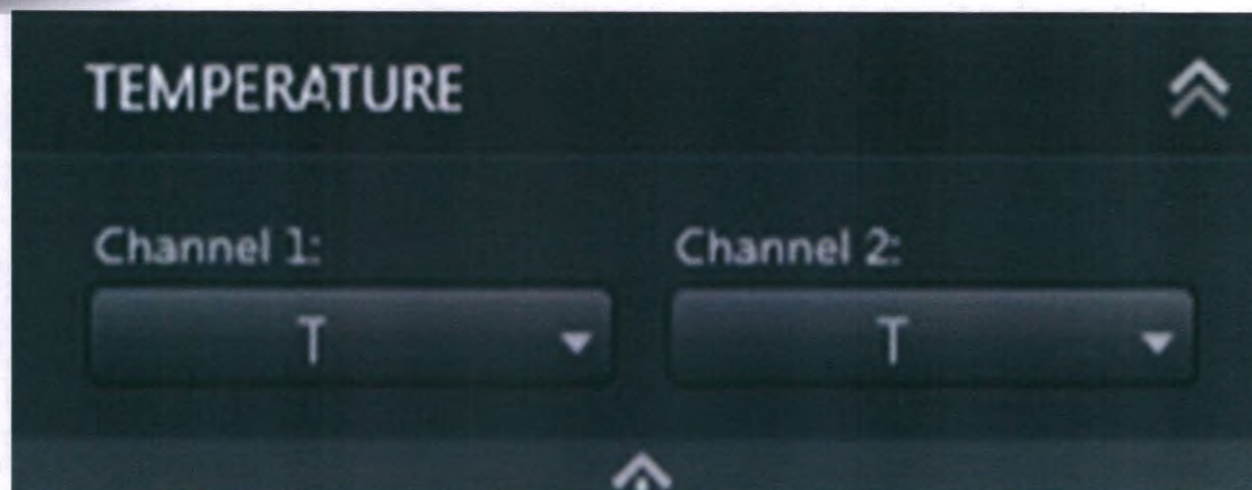



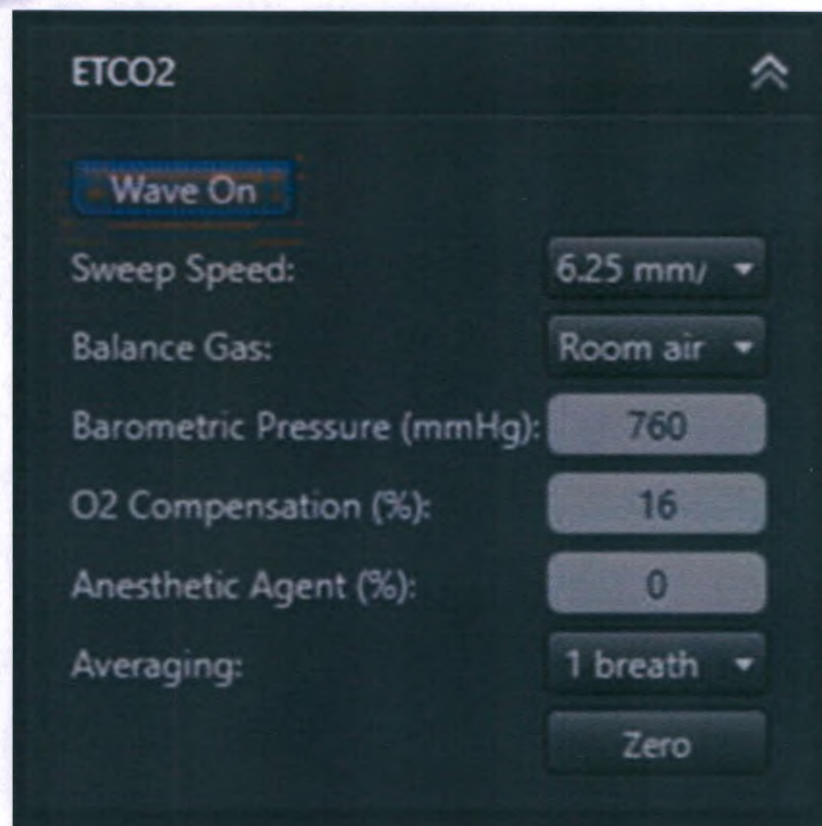


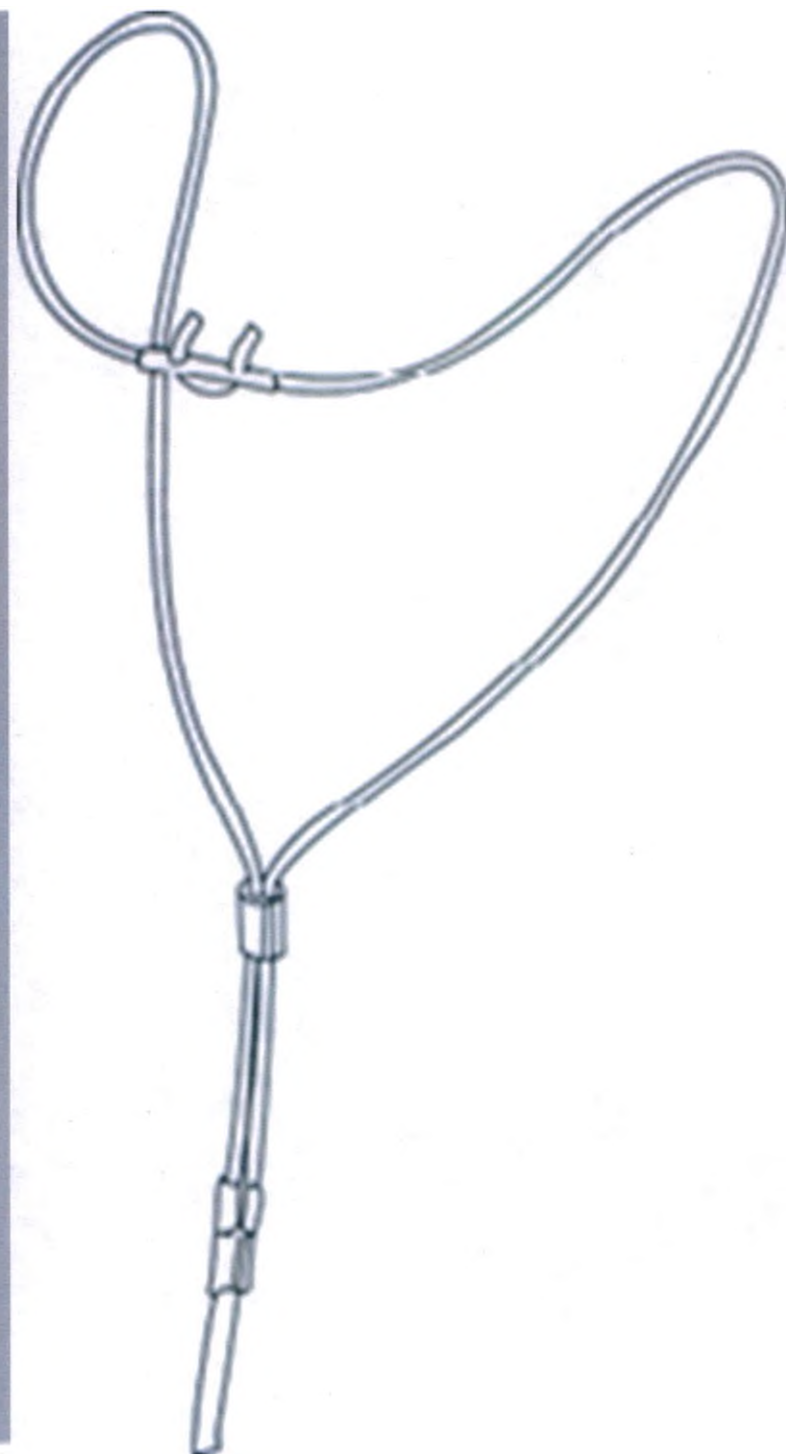

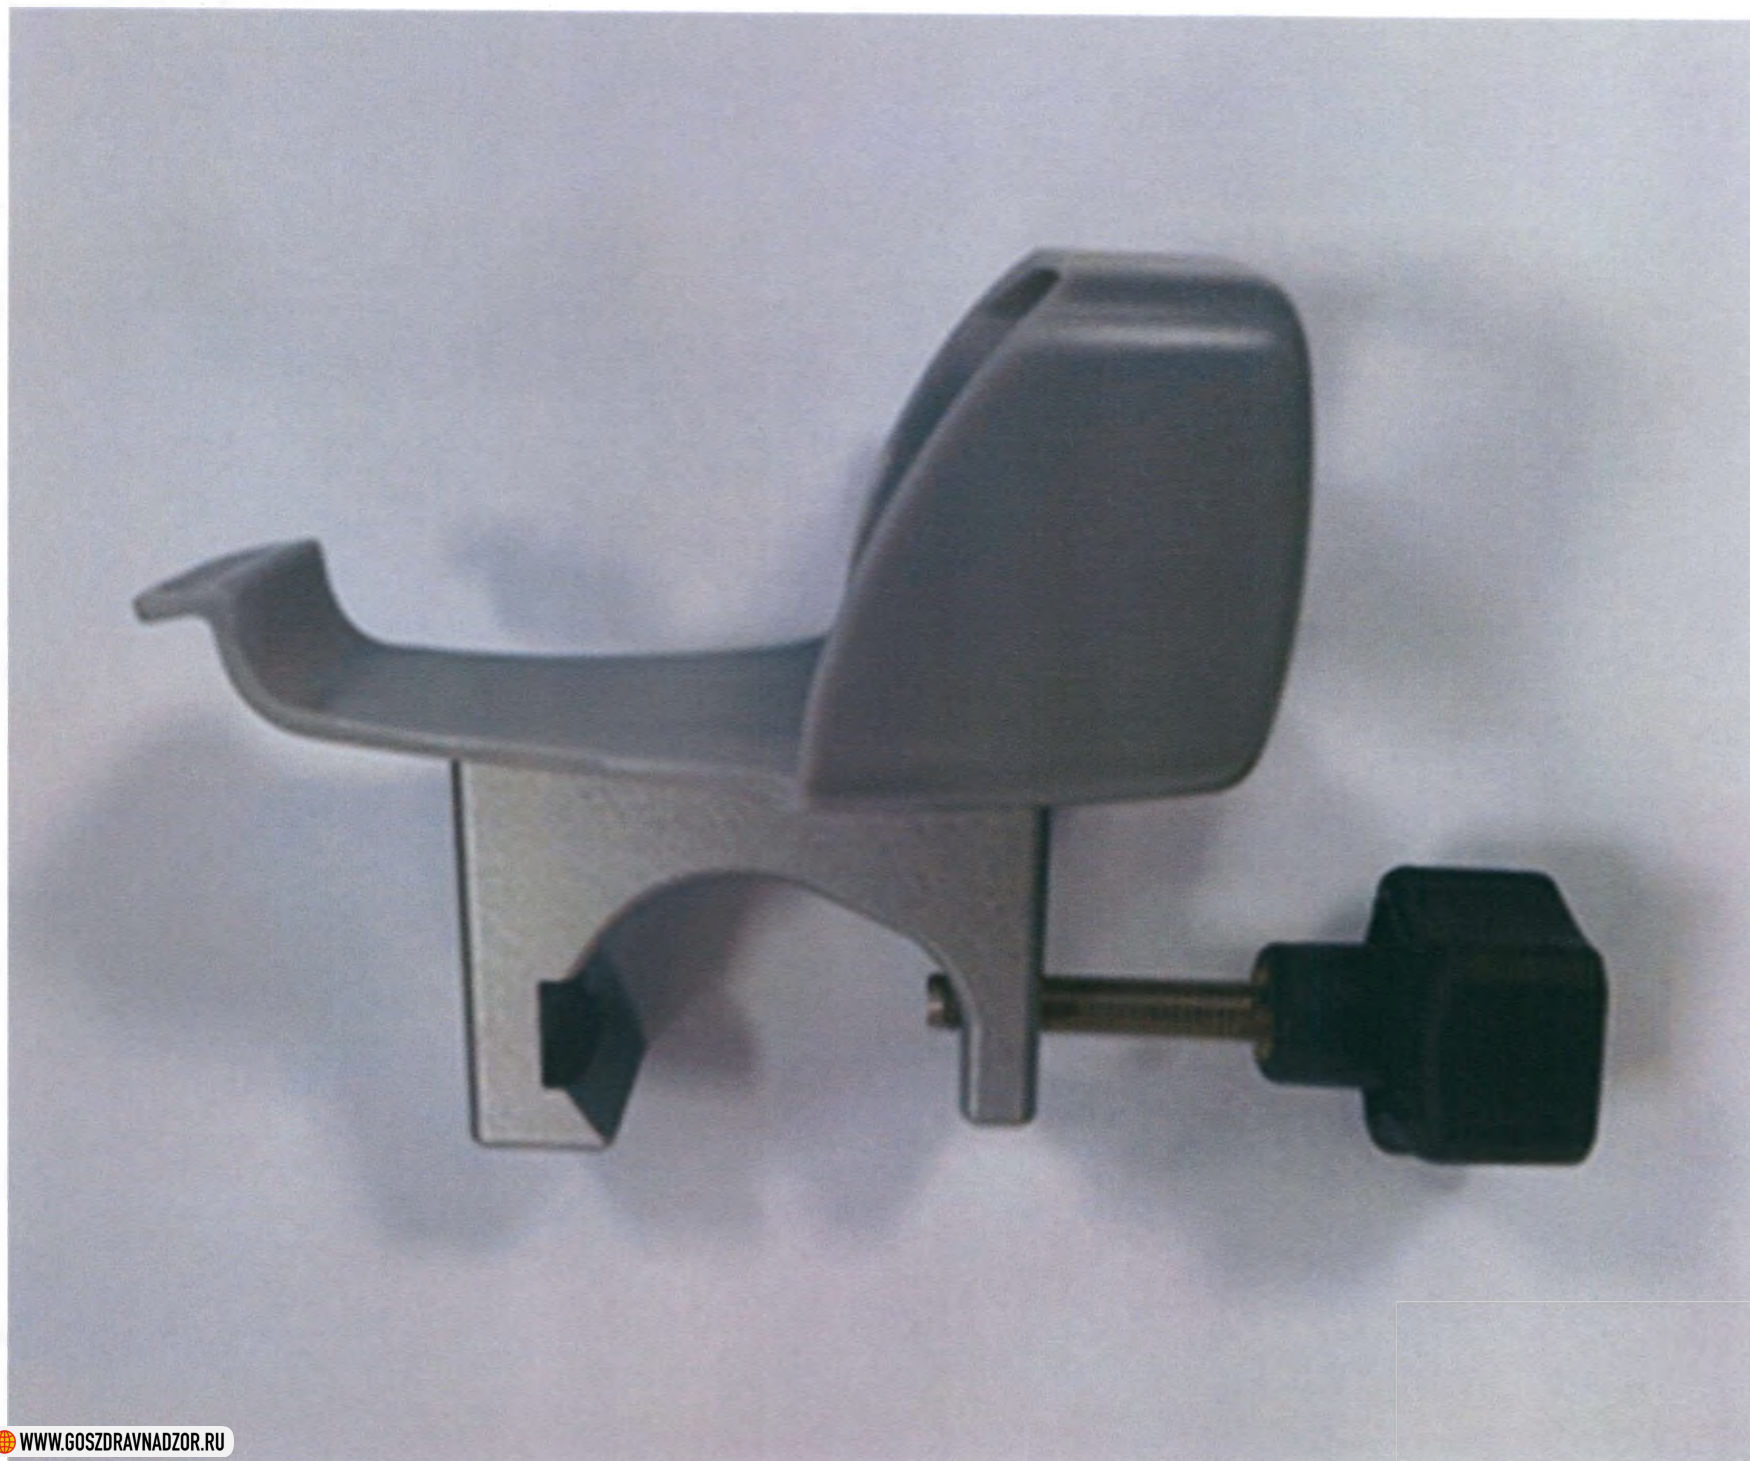

73. Датчик температурный, не более 5 шт.

011

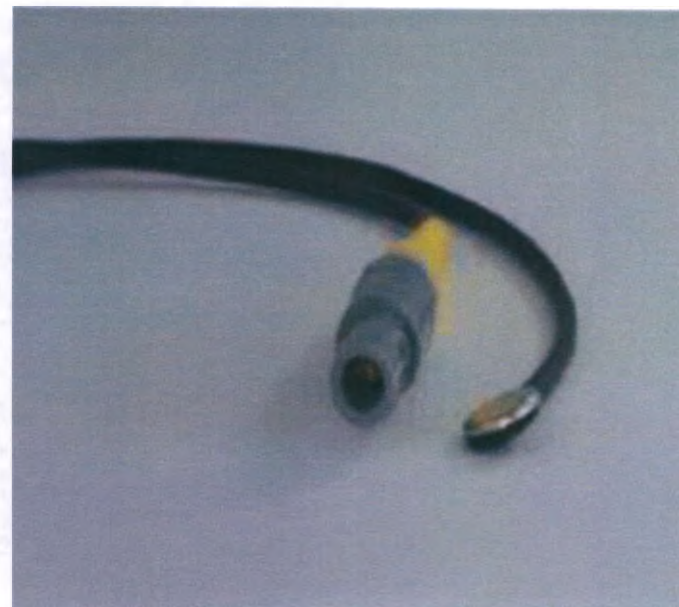

Датчик кожный, многоразовый для взрослых



Датчик ректальный многоразовый для взрослых.

73. Датчик температурный, не более 5 шт.

0/2




Датчик центральный многоразовый для взрослых

74. Кабель соединительный для температурных датчиков, не более 3 шт.



75. Кабель для выходного сигнала AUX, не более 3 шт.

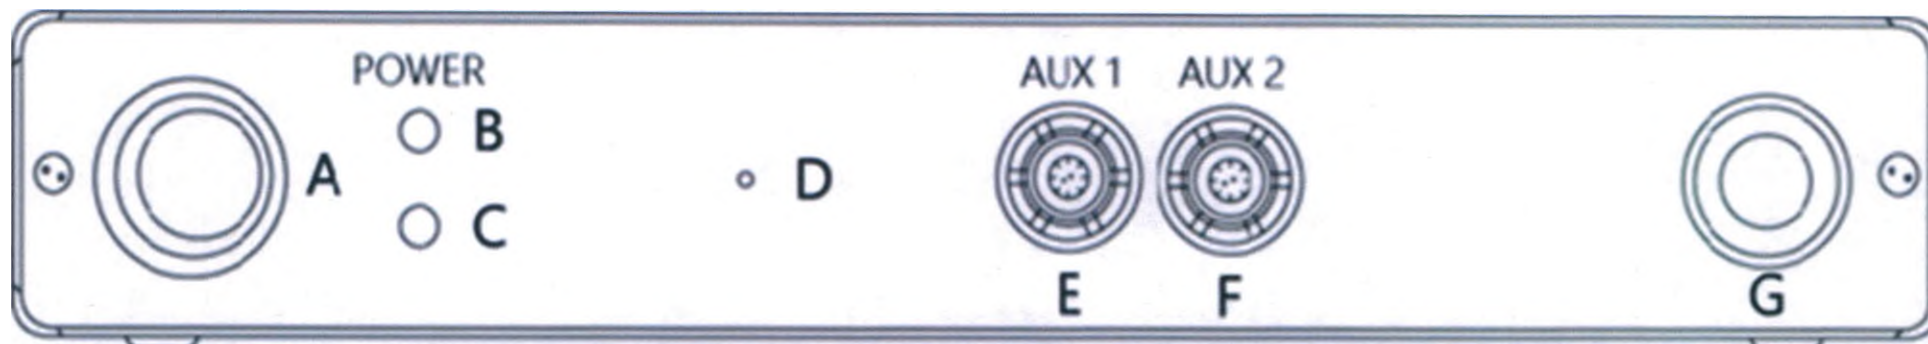



77. Датчик многоразовый SpO₂, не более 3 шт.



78. Кабель для неинвазивного измерения давления, не более 3 шт.





80. Комплект принадлежностей для большого монитора (система видеопередачи для операционной).




Подставка



Передатчик DVI 1



Передатчик DVI 2

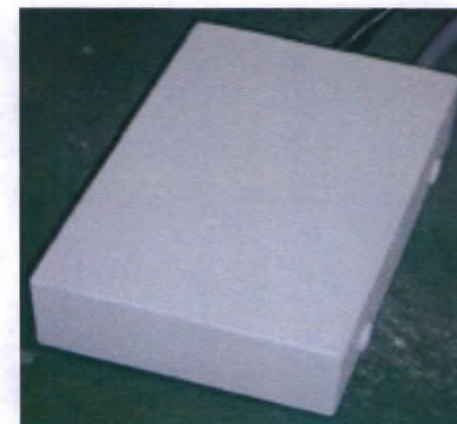

Блок питания для монитора с большим экраном




Сетевой концентратор




82. Комплект для защиты от магнитных полей (магнитный экран), в вариантах исполнения: - для FPD 12x16 дюймов;


001

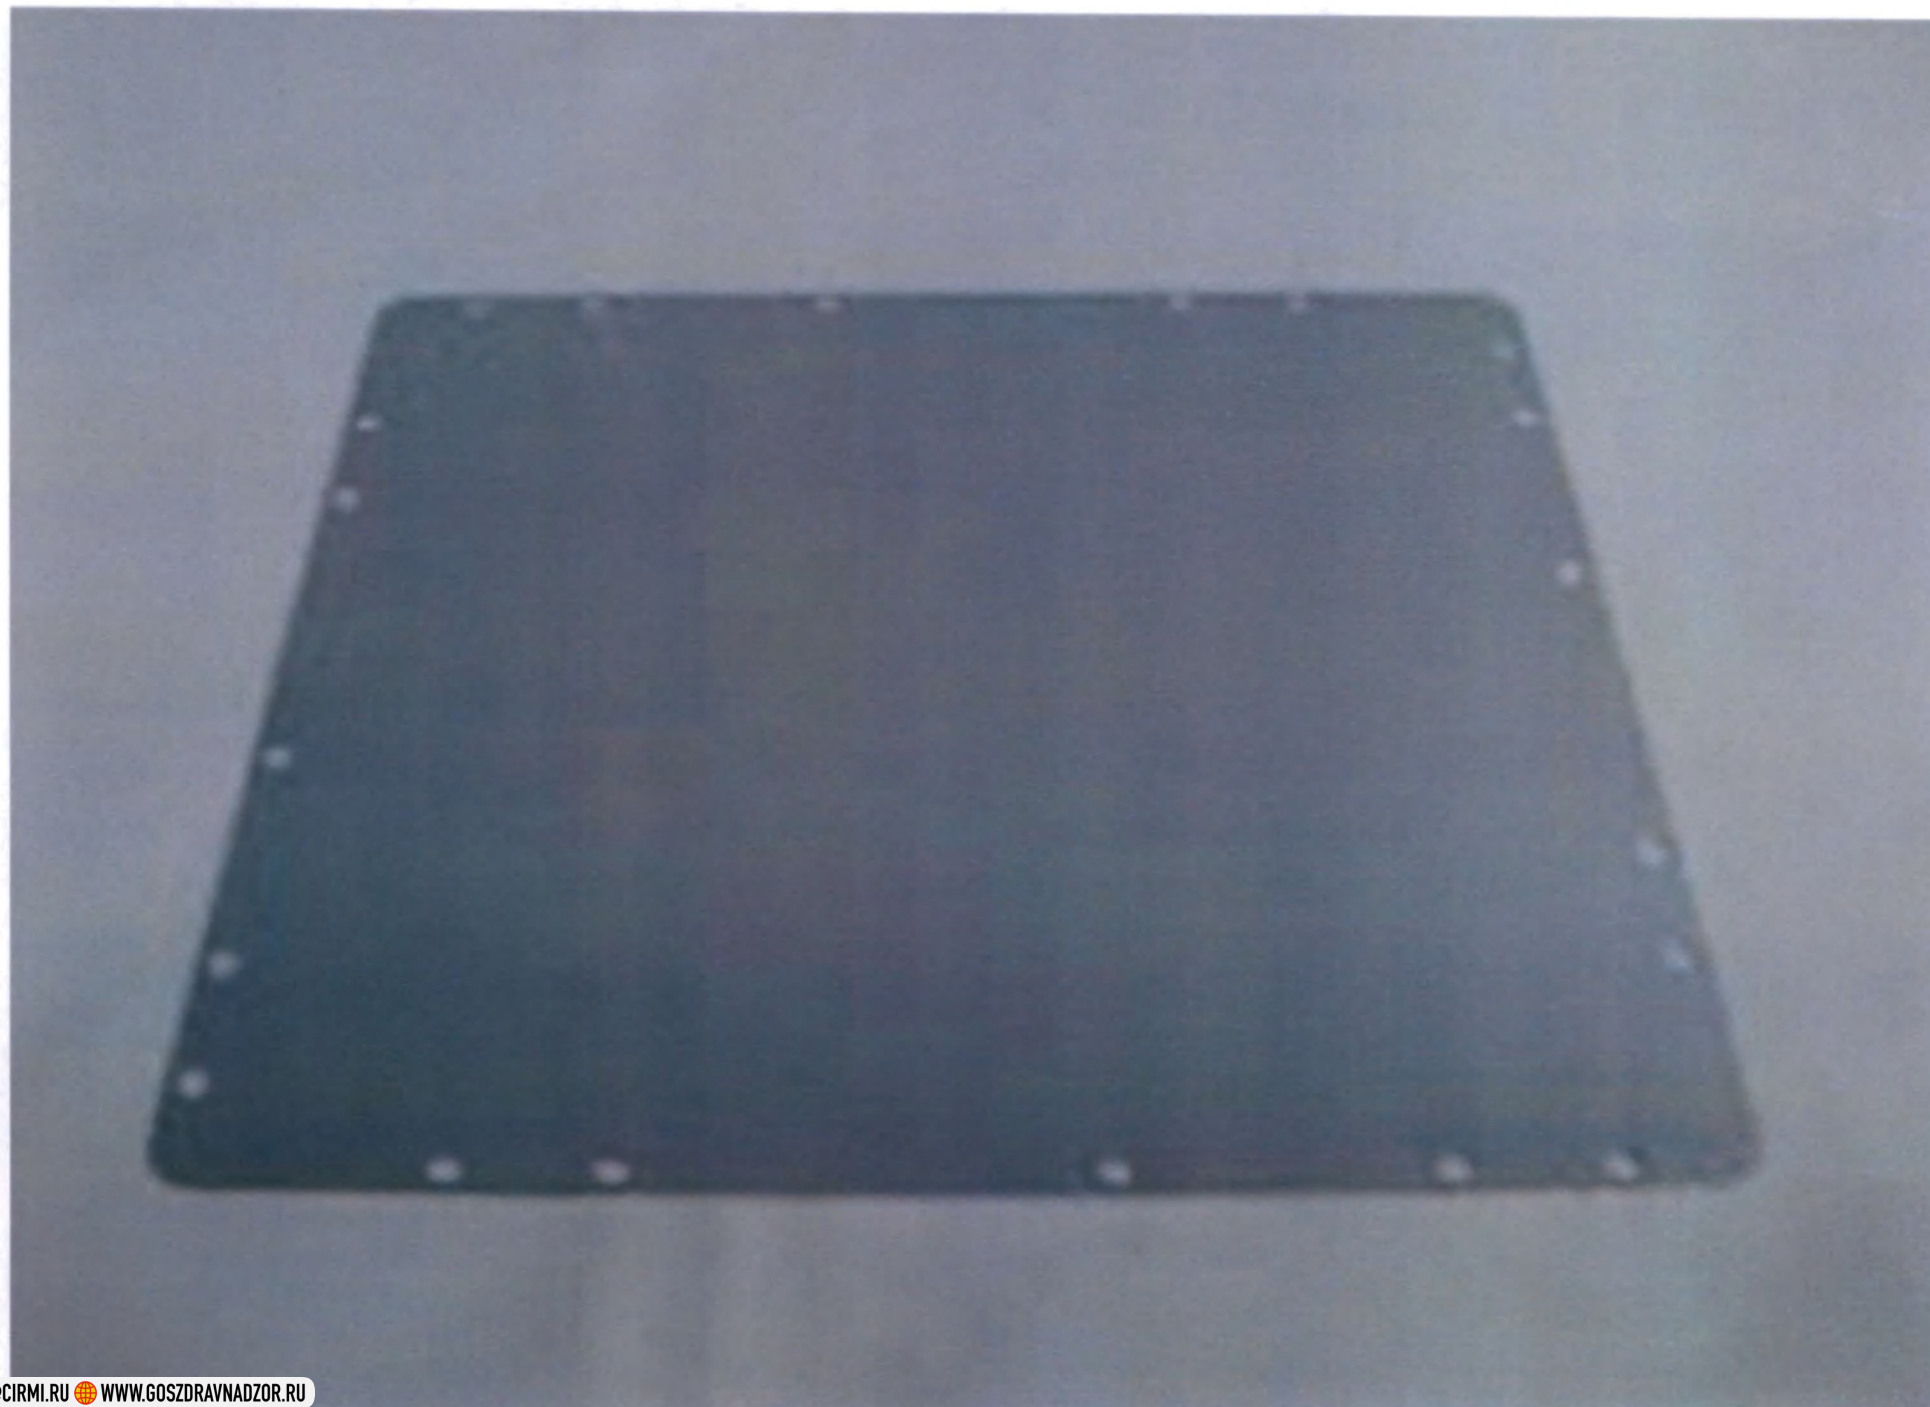


82. Комплект для защиты от магнитных полей (магнитный экран), в вариантах исполнения: - для 12-дюймового FPD.

006

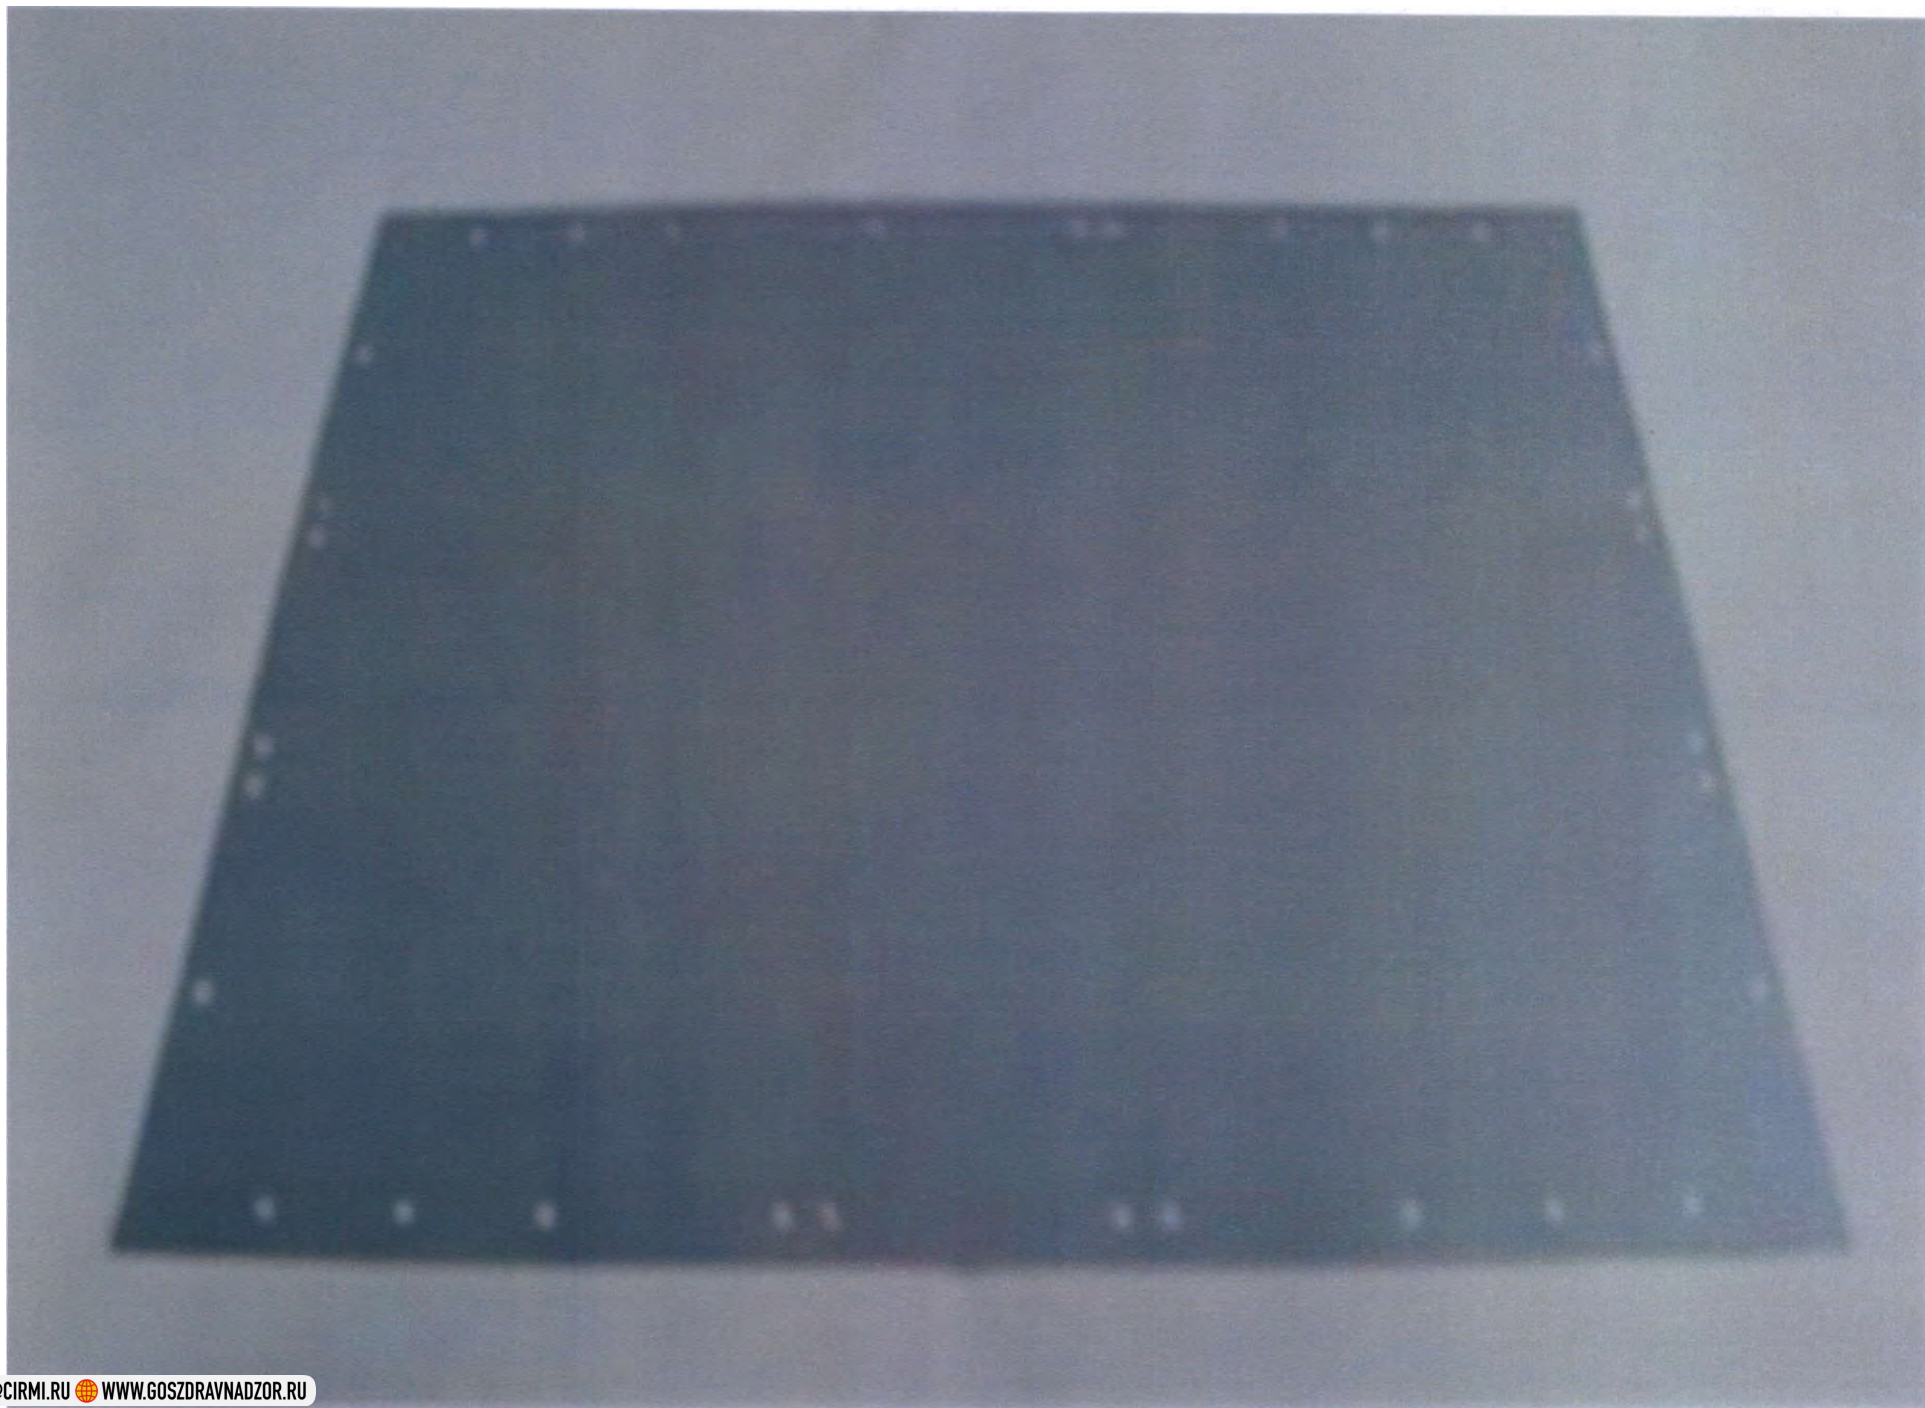

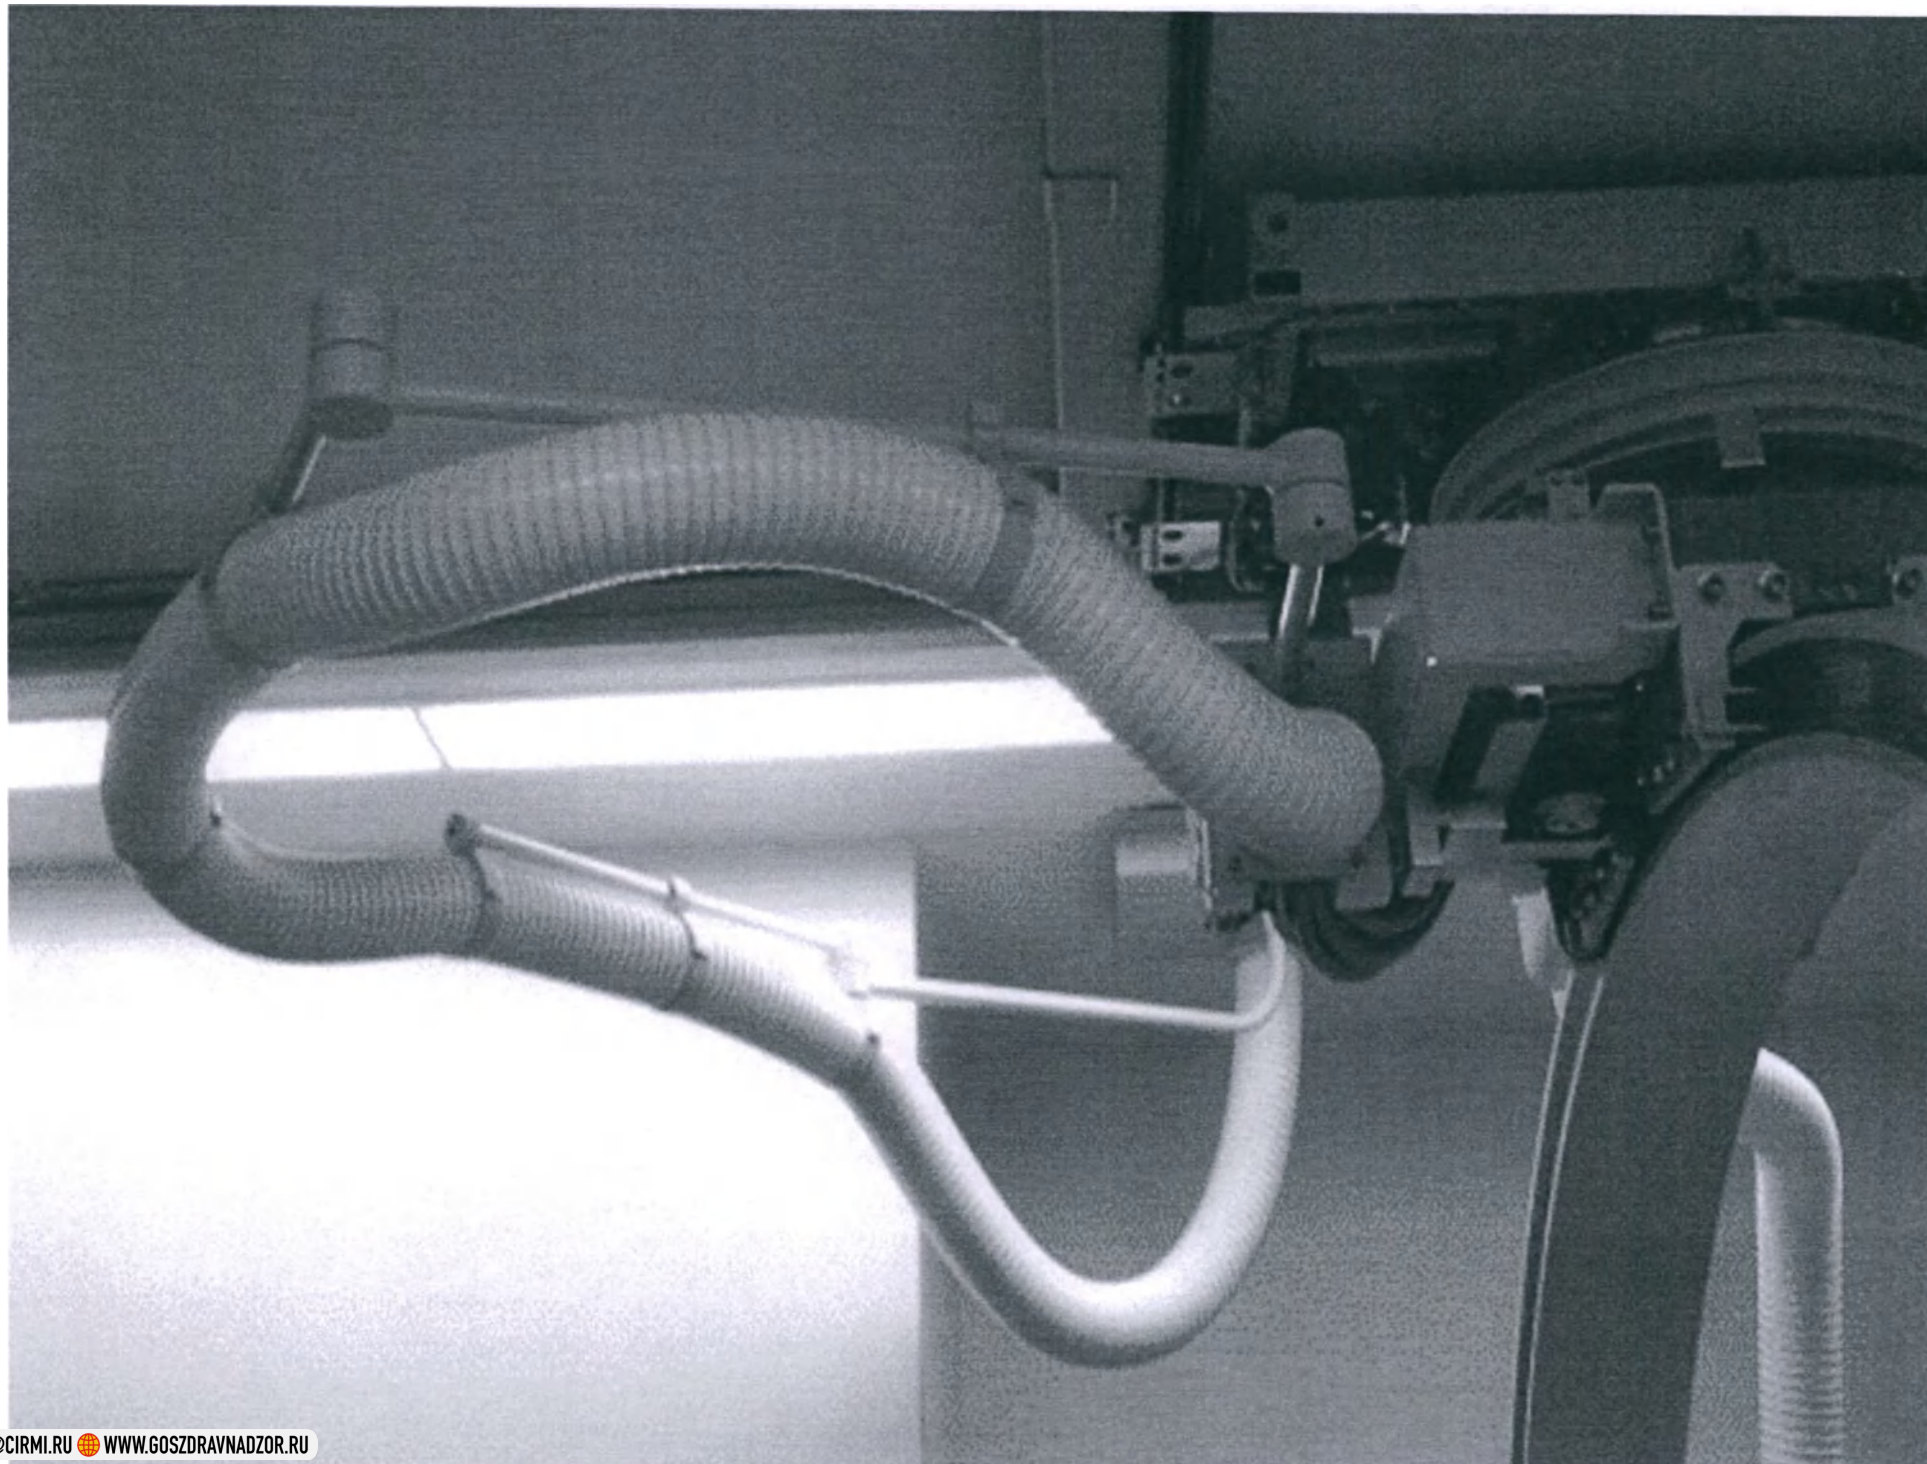


84. Комплект фиксатора поворота опорной колонны (для CAS-880A)

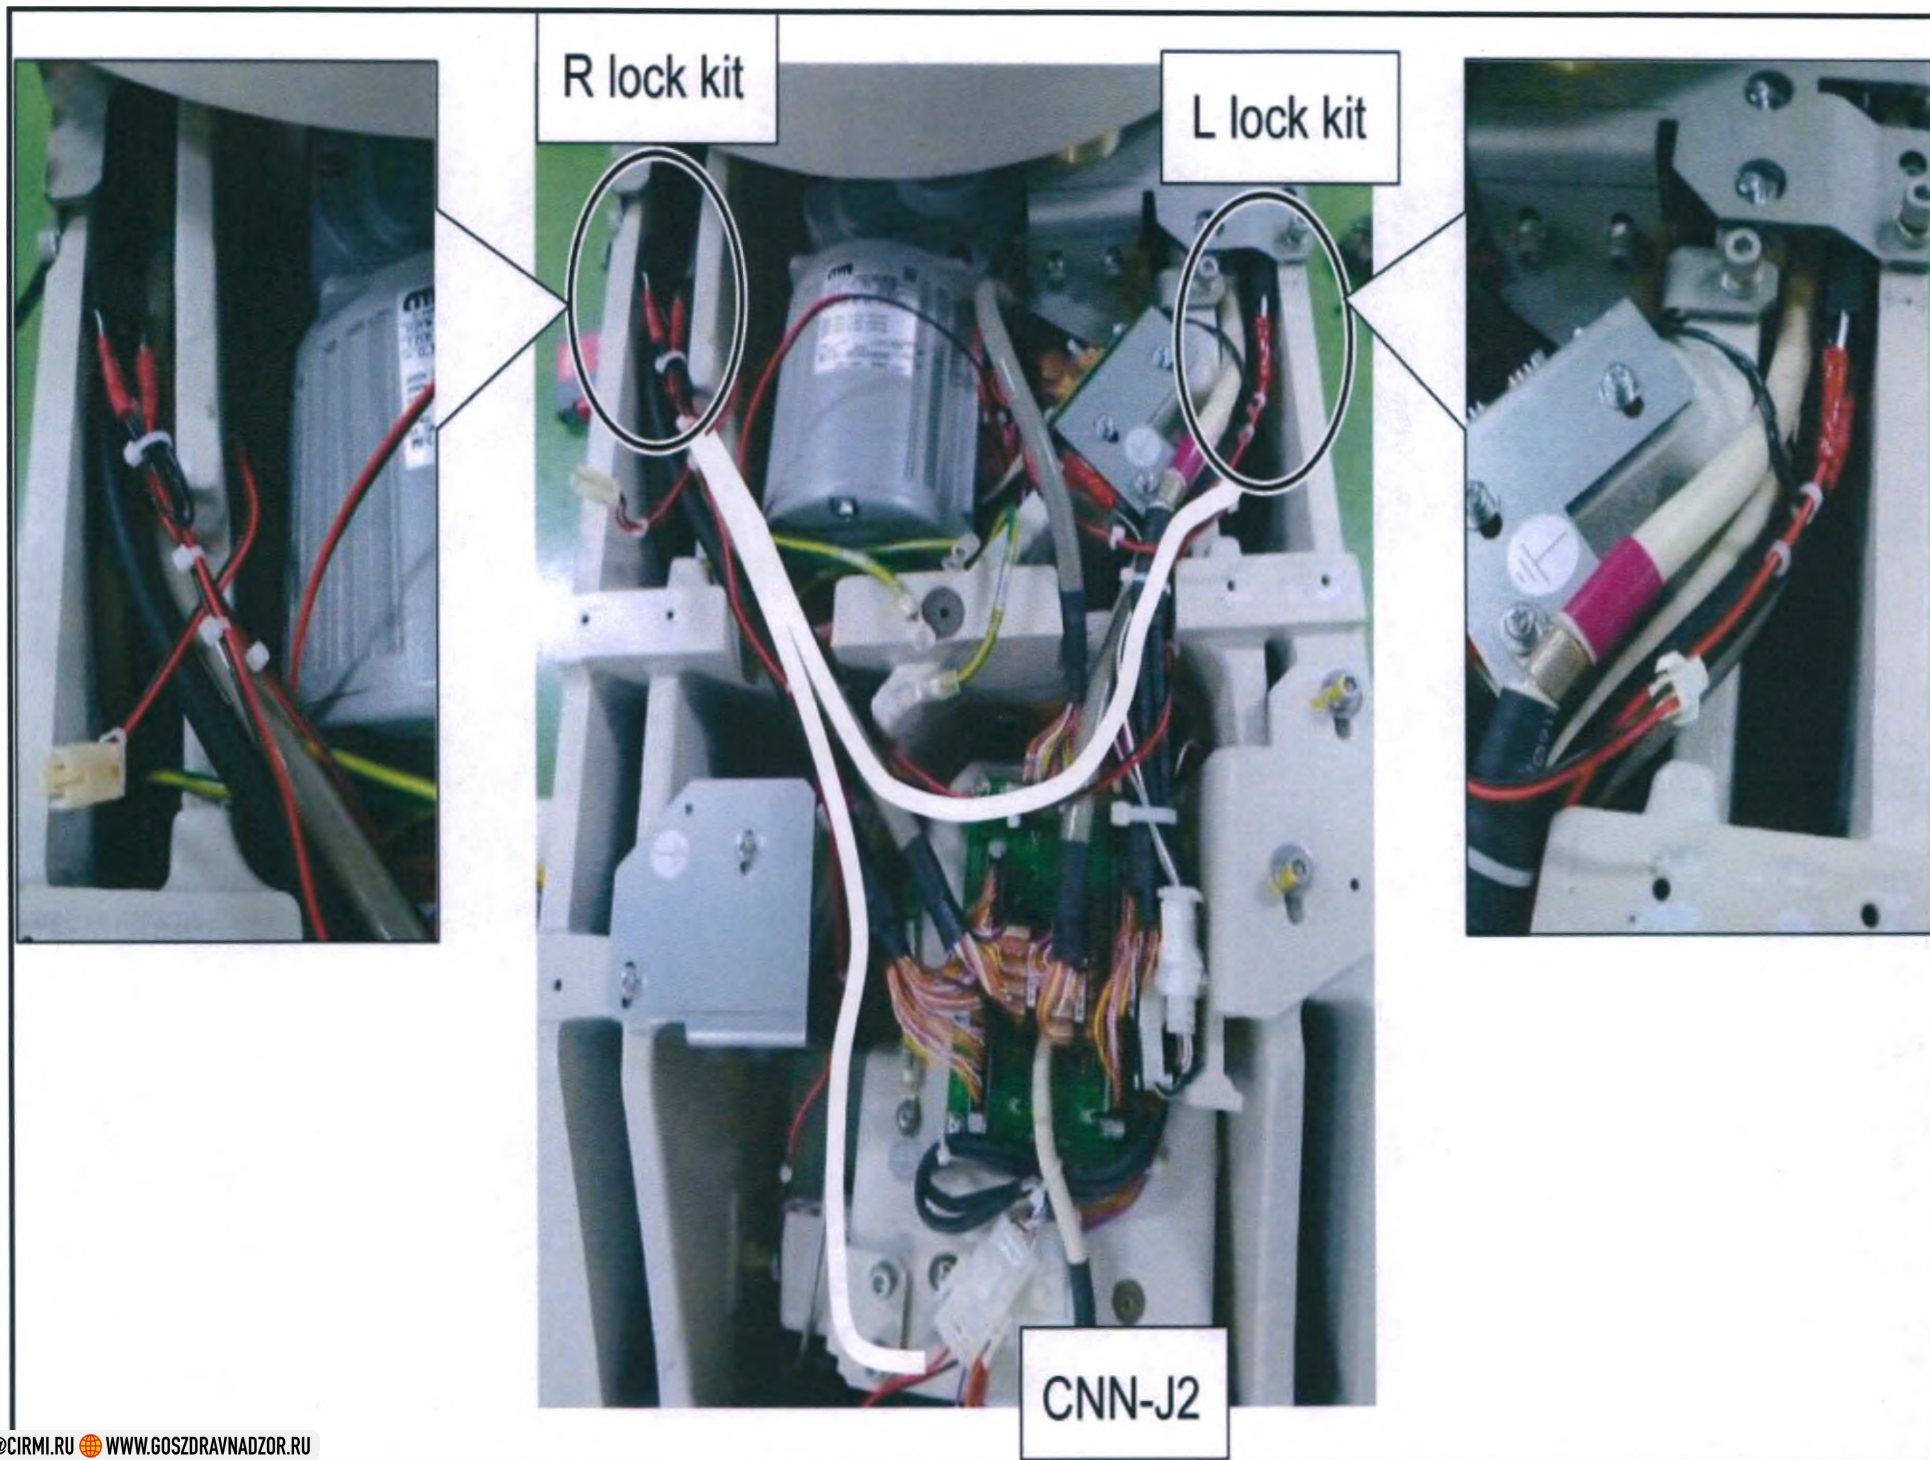



Комплект встроен
внутрь
САТ-850В/В1

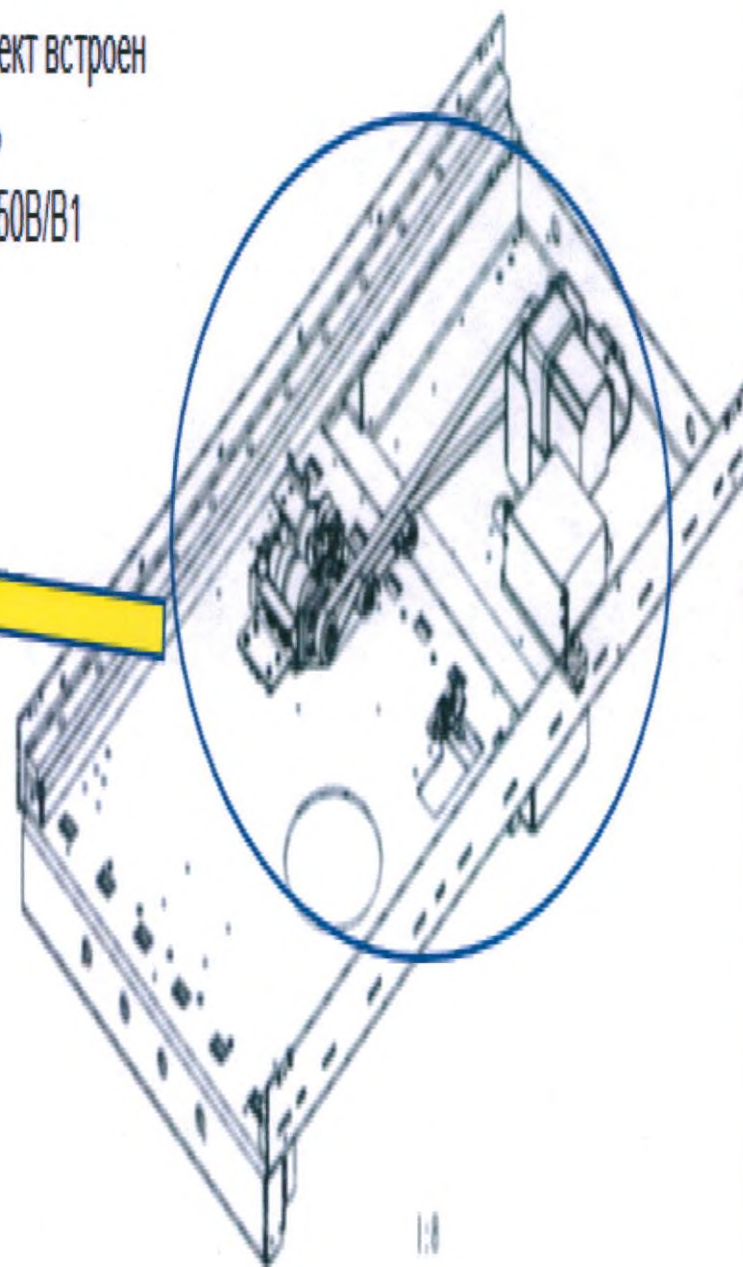

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - программное обеспечение основное - 1 шт.

Study List User

Search: **default** QueryPatients

Filter By: Patient ID, Patient Name, Date of Birth, Accession Number, Study Description, Modality, Study Date

Results: Searching default archive for Modality Any Study Date Any Status any

Status	Patient Name	Patient ID	Sex	Modality	# Images	Study Date/Time	Accession #	Study Description
	Embolication Plan	20040408	F	CT	762	08 Apr 2004 09:17		
	ROOT SACRAL VERTEBRALITY	UR2V-001	F	CT	3238	24 Mar 2004 13:05	VISION	
	CHEST CTA/PE, SURF XV	UR2V-TL...	F	CT	2509	07 Feb 2004 17:08	ONE_VISION	
	CHEST CTA/PE, SURF XV	UR2V-TL...	F	CT	2471	05 Feb 2004 22:26	ONE_VISION	
	CHEST CTA/PE, SURF XV	UR2V-TL...	F	CT	3204	05 Feb 2004 15:08	ONE_VISION	
	DSA HEAD 131	3D-INFX...	KA	SA	1627	14 Dec 2003 09:29		INFINIX
	LC BODY 086	LC-INFX...	KA	SA	1542	25 Aug 2003 13:36		INFINIX
	LC BODY 088	LC-INFX...	KA	SA	384	25 Aug 2003 09:58		INFINIX
	CAA	9301777	M	KA	1624	08 Aug 2003 06:04	2003040790	
	MAPCA			CT	1807	01 May 2003 14:18		CTA
	VOLUME, MELCOY	12345		CT	4402	01 May 2003 12:54		Card Core CTA
	Brain COW Subtraction	MCA Ar...	F	CT, SA	702	05 Apr 2003 20:58	ONE_VISION	CT Angiogram C...
	MR AO PULM	12377	MR		124	18 Mar 2003 08:11		Card Cathac Fun...
	CEREBRAL ANEURYSM	3D-INFX...		KA	513	11 Jun 2004 14:07	ABC	
	IT ARD RETALS CENTRA ONE RATH BOY SPN	3AB-CE...	M	MR	1138	05 May 2004 15:20		
	3D DSA L-Vert-Aneurysm MR	3D DSA...	F	KA	1625	18 Feb 2004 07:06		
	3D DSA LSCA Aneurysm E12	3D DSA...	F	KA	512	27 Jan 2004 08:02		

Last updated: 12m ago Total results: 35

Applications: **KA 3D Volume** **Cerebral Aneurysm Analysis** **Embolication Plan**

CEREBRAL ANEURYSM | 3D-INFX-002 | 11 Jun 2004 14:07 Tools List Images


Open

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - персональный компьютер - 1 шт.

001




86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - клавиатура - 1 шт.

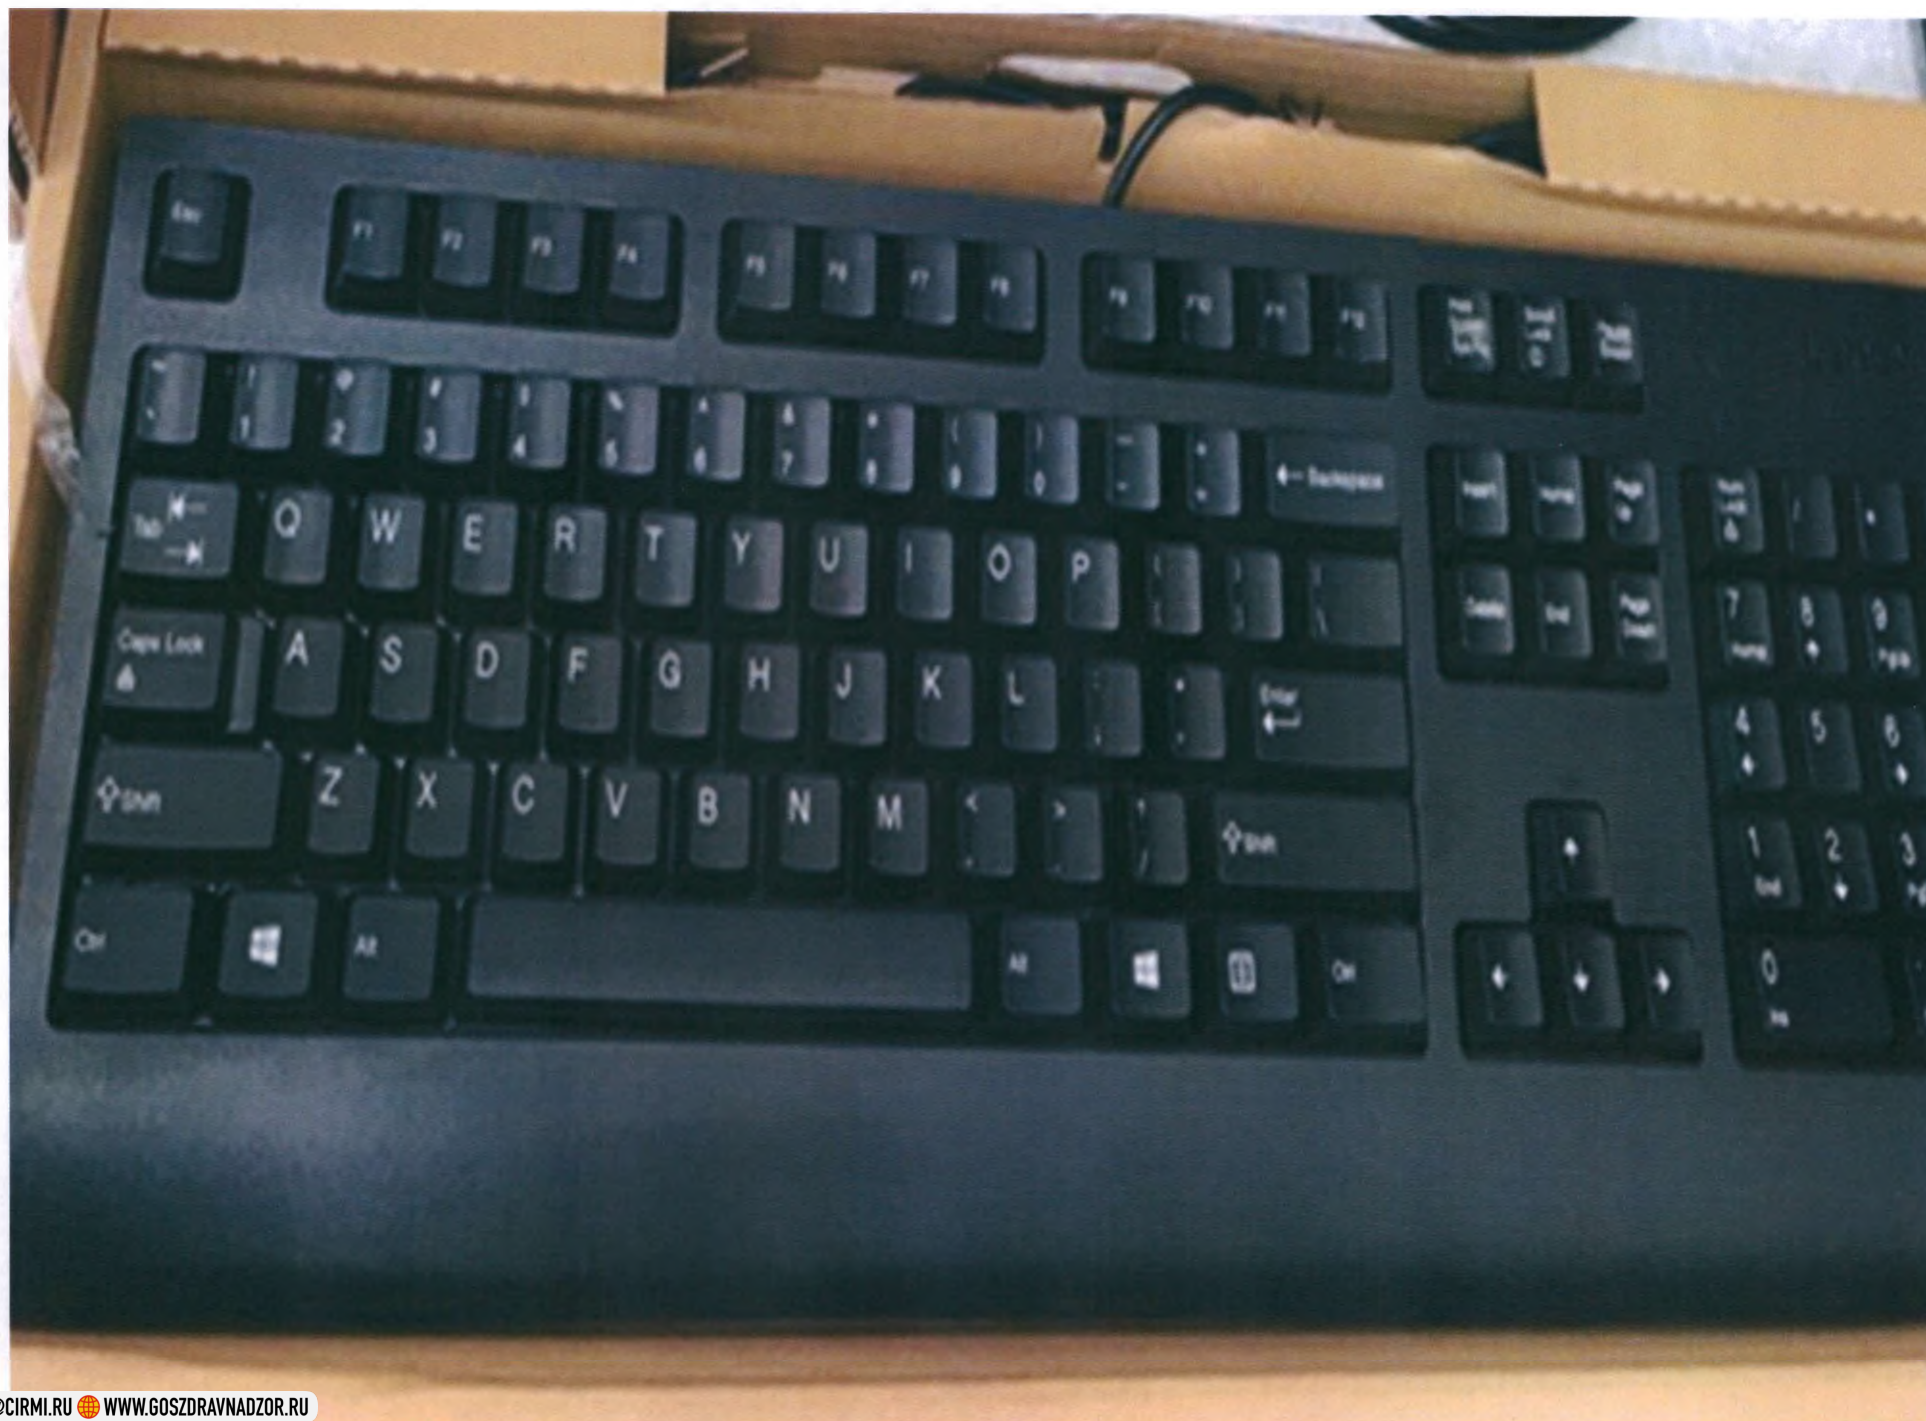

86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - манипулятор «мышь» - 1 шт.

009

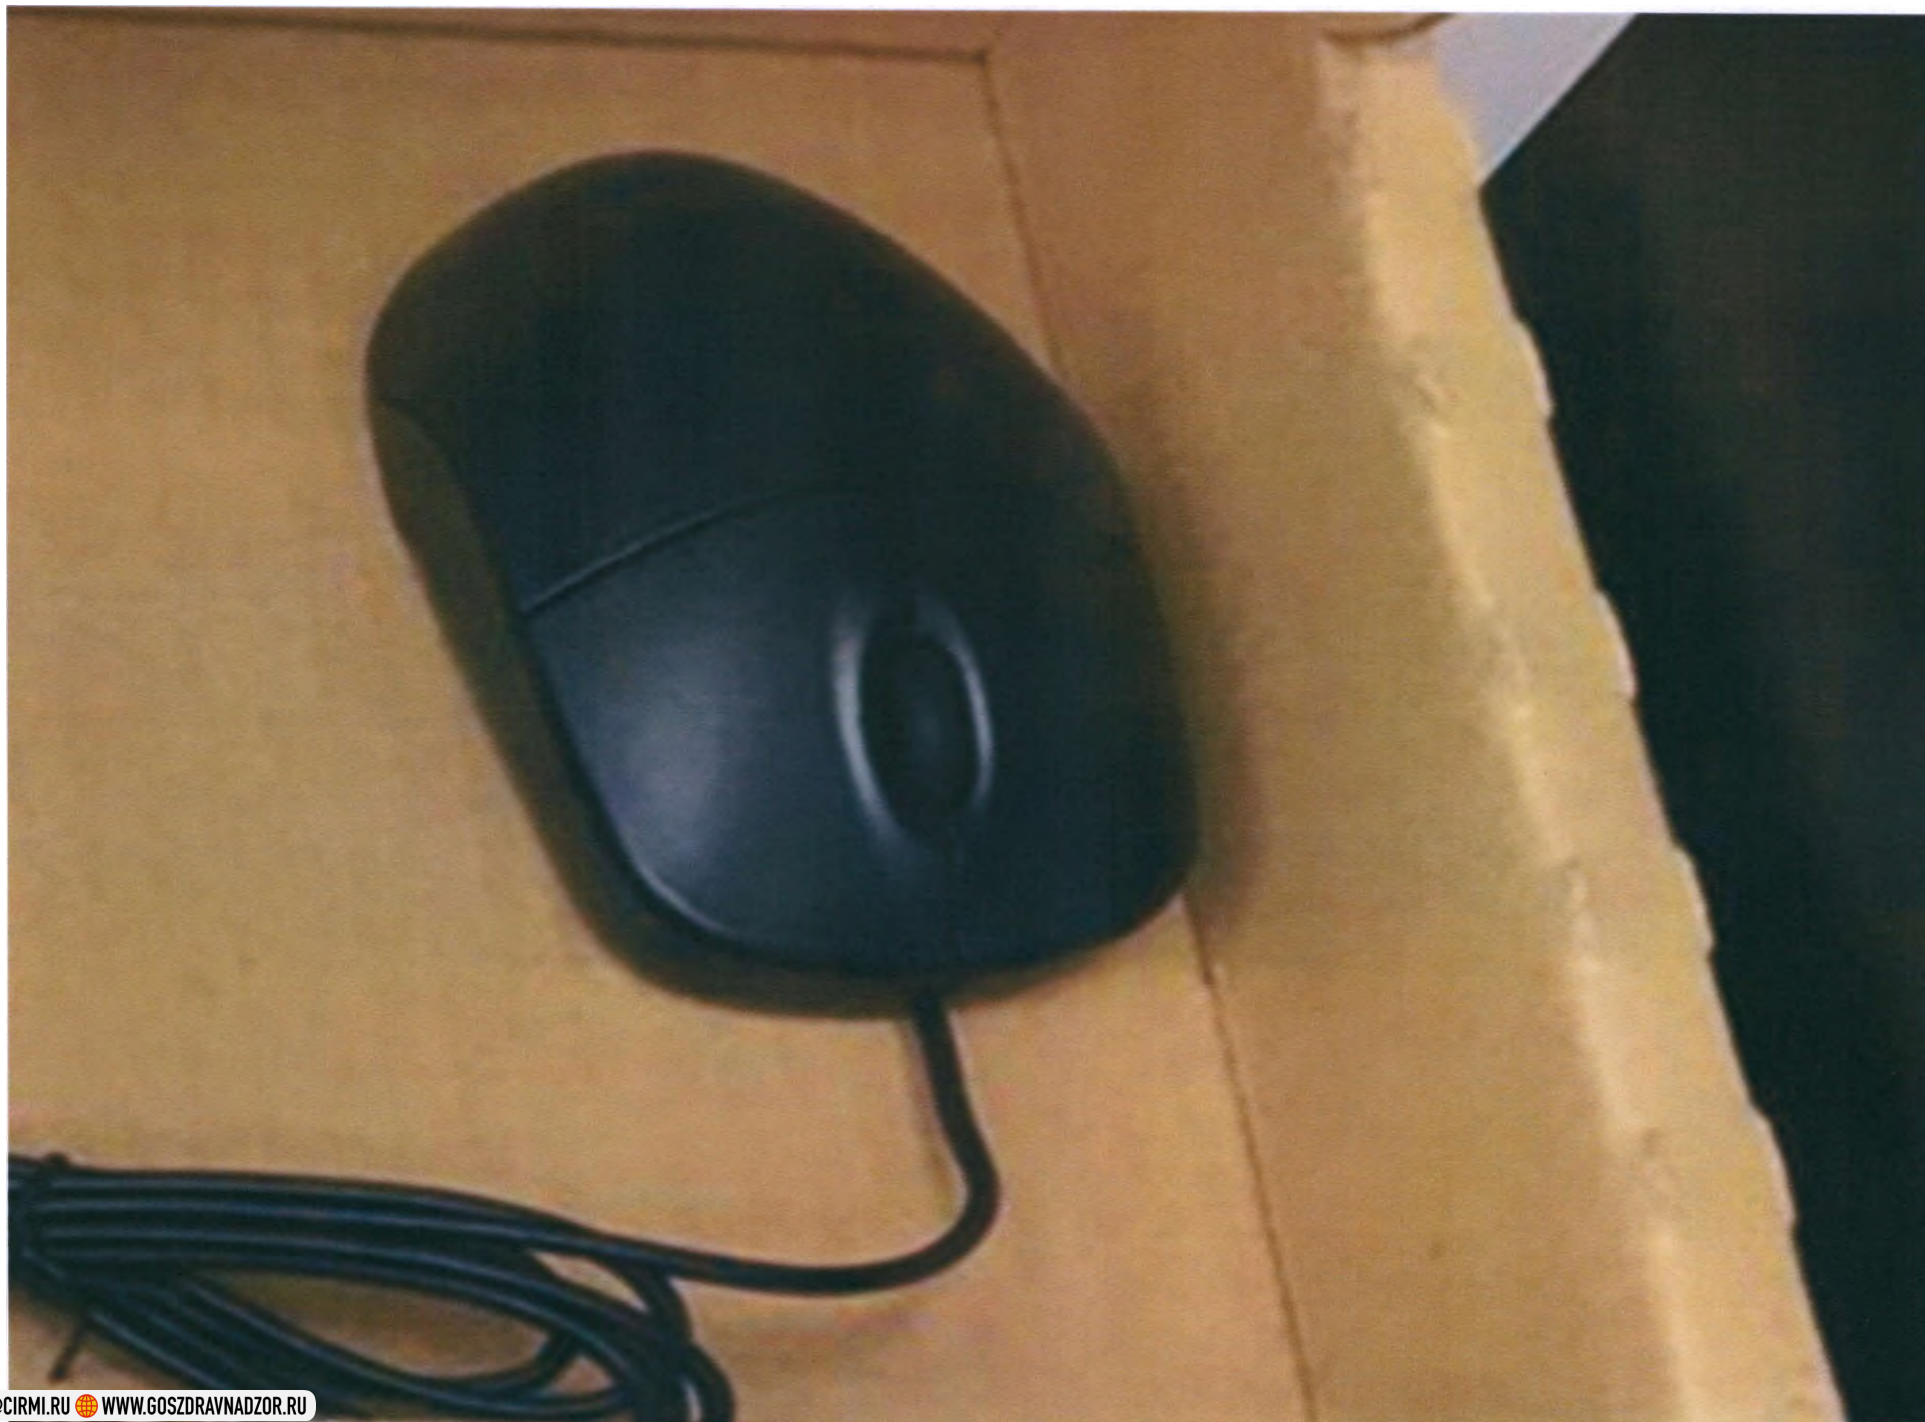


86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - концентратор - 1 шт.

030



86. Ангиографическая рабочая станция, в составе: - комплект кабелей - 4 шт.



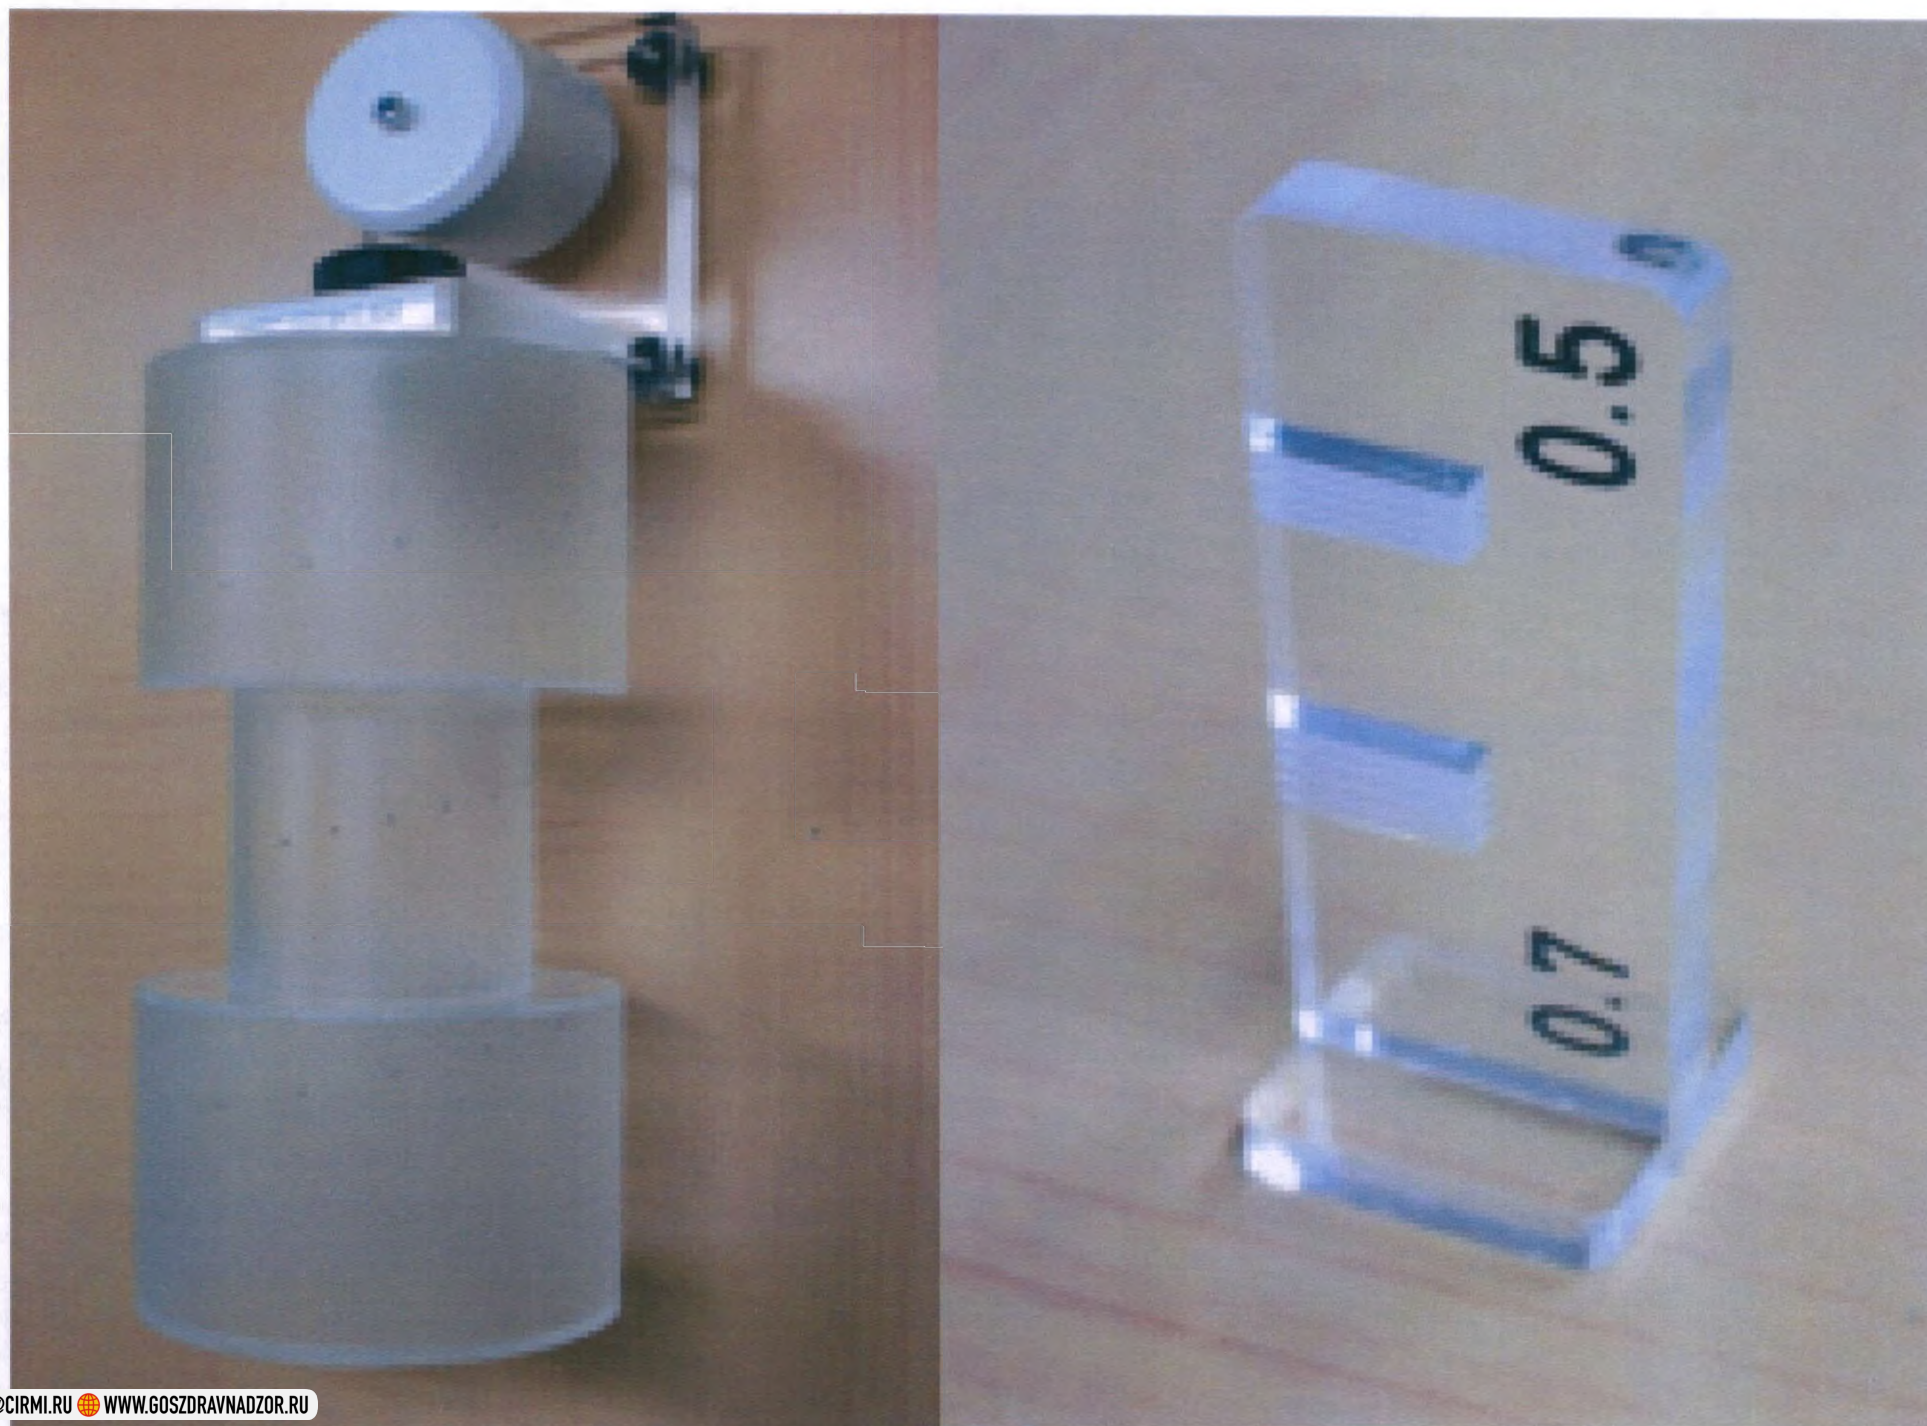

87. Монитор для Ангиографической рабочей станции - не более 4 шт.


09/3



88. Комплект дополнительного монитора для Ангиографической рабочей станции.



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет интерфейса для клинического анализа;

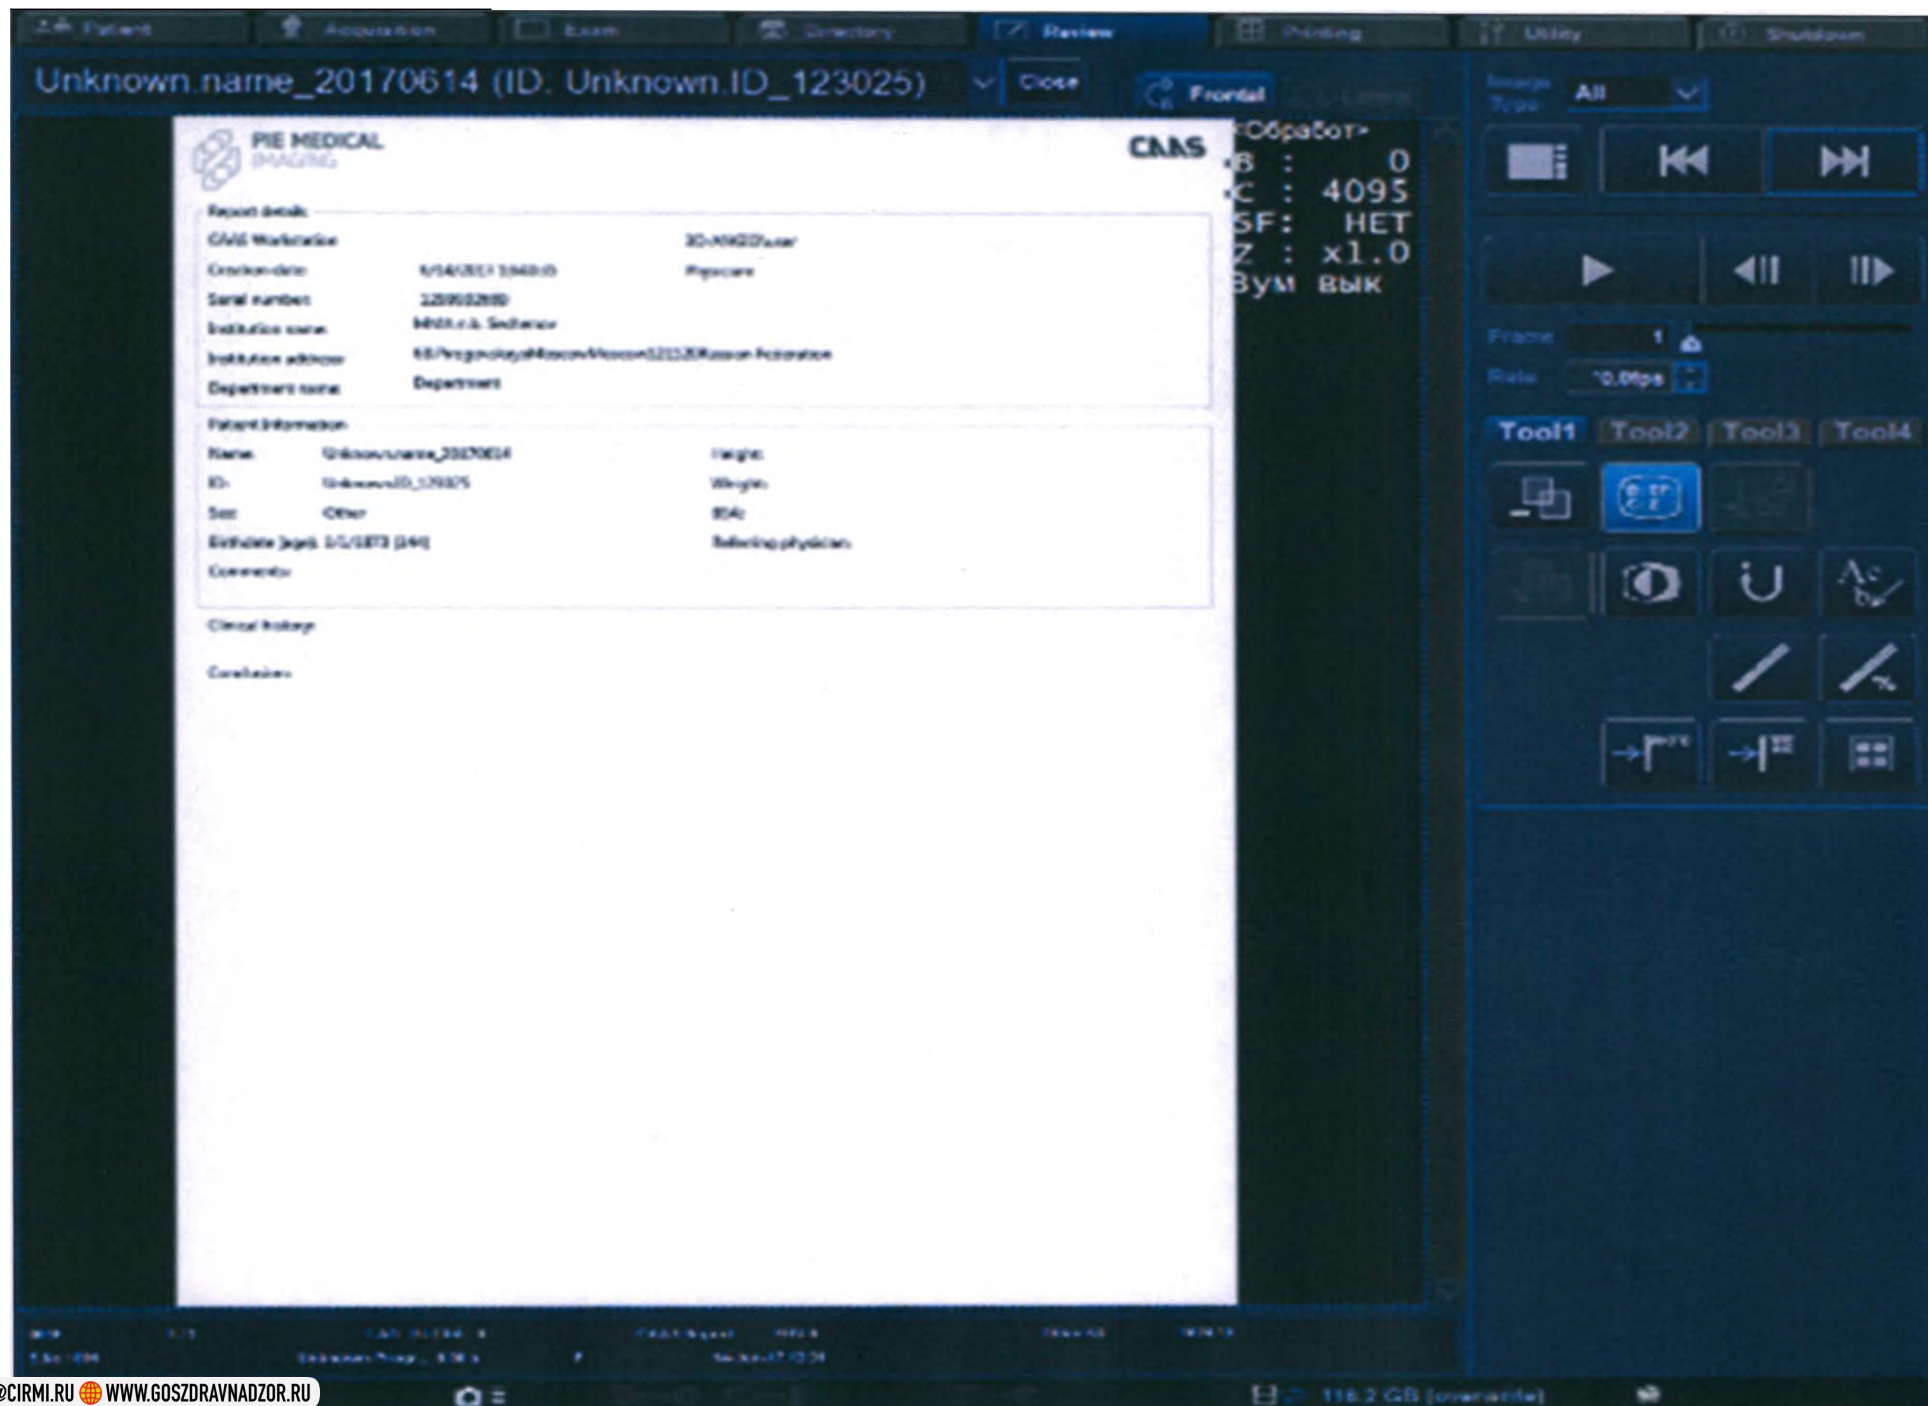

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QCA (анализ коронарных артерий)

CAAS Workstation 7.1.1 - 3DAdmin

Report
 - Overview Page
 - Viewing
 - QCA 1

Report details

CAAS Workstation	3D-ANGBO3Dadmin
Creation date	15.06.2017 17:11:40
Serial number	1299932669
Institution name	MSA n.b. Sechenov
Institution address	68.PirogovskayaMoscowMoscow125120Russian Federation
Department name	Department

Patient Information

Name	DROENKOVA RAZSA MIHAILOVNA	Height	167 cm
ID	37 476/2017	Weight	110 kg
Sex	Female	BSA	2.16 m ²
Birthdate (age)	20.03.1948 (69)	Referring physician	

Comments:

Clinical history

Conclusion


CAAS Workstation 7.1.1

1 / 2

CAAS

DROENKOVA RAZSA MIHAIL...
 20.03.1948
 Female
 XAJ0170615114027

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QVA (анализ сосудов)

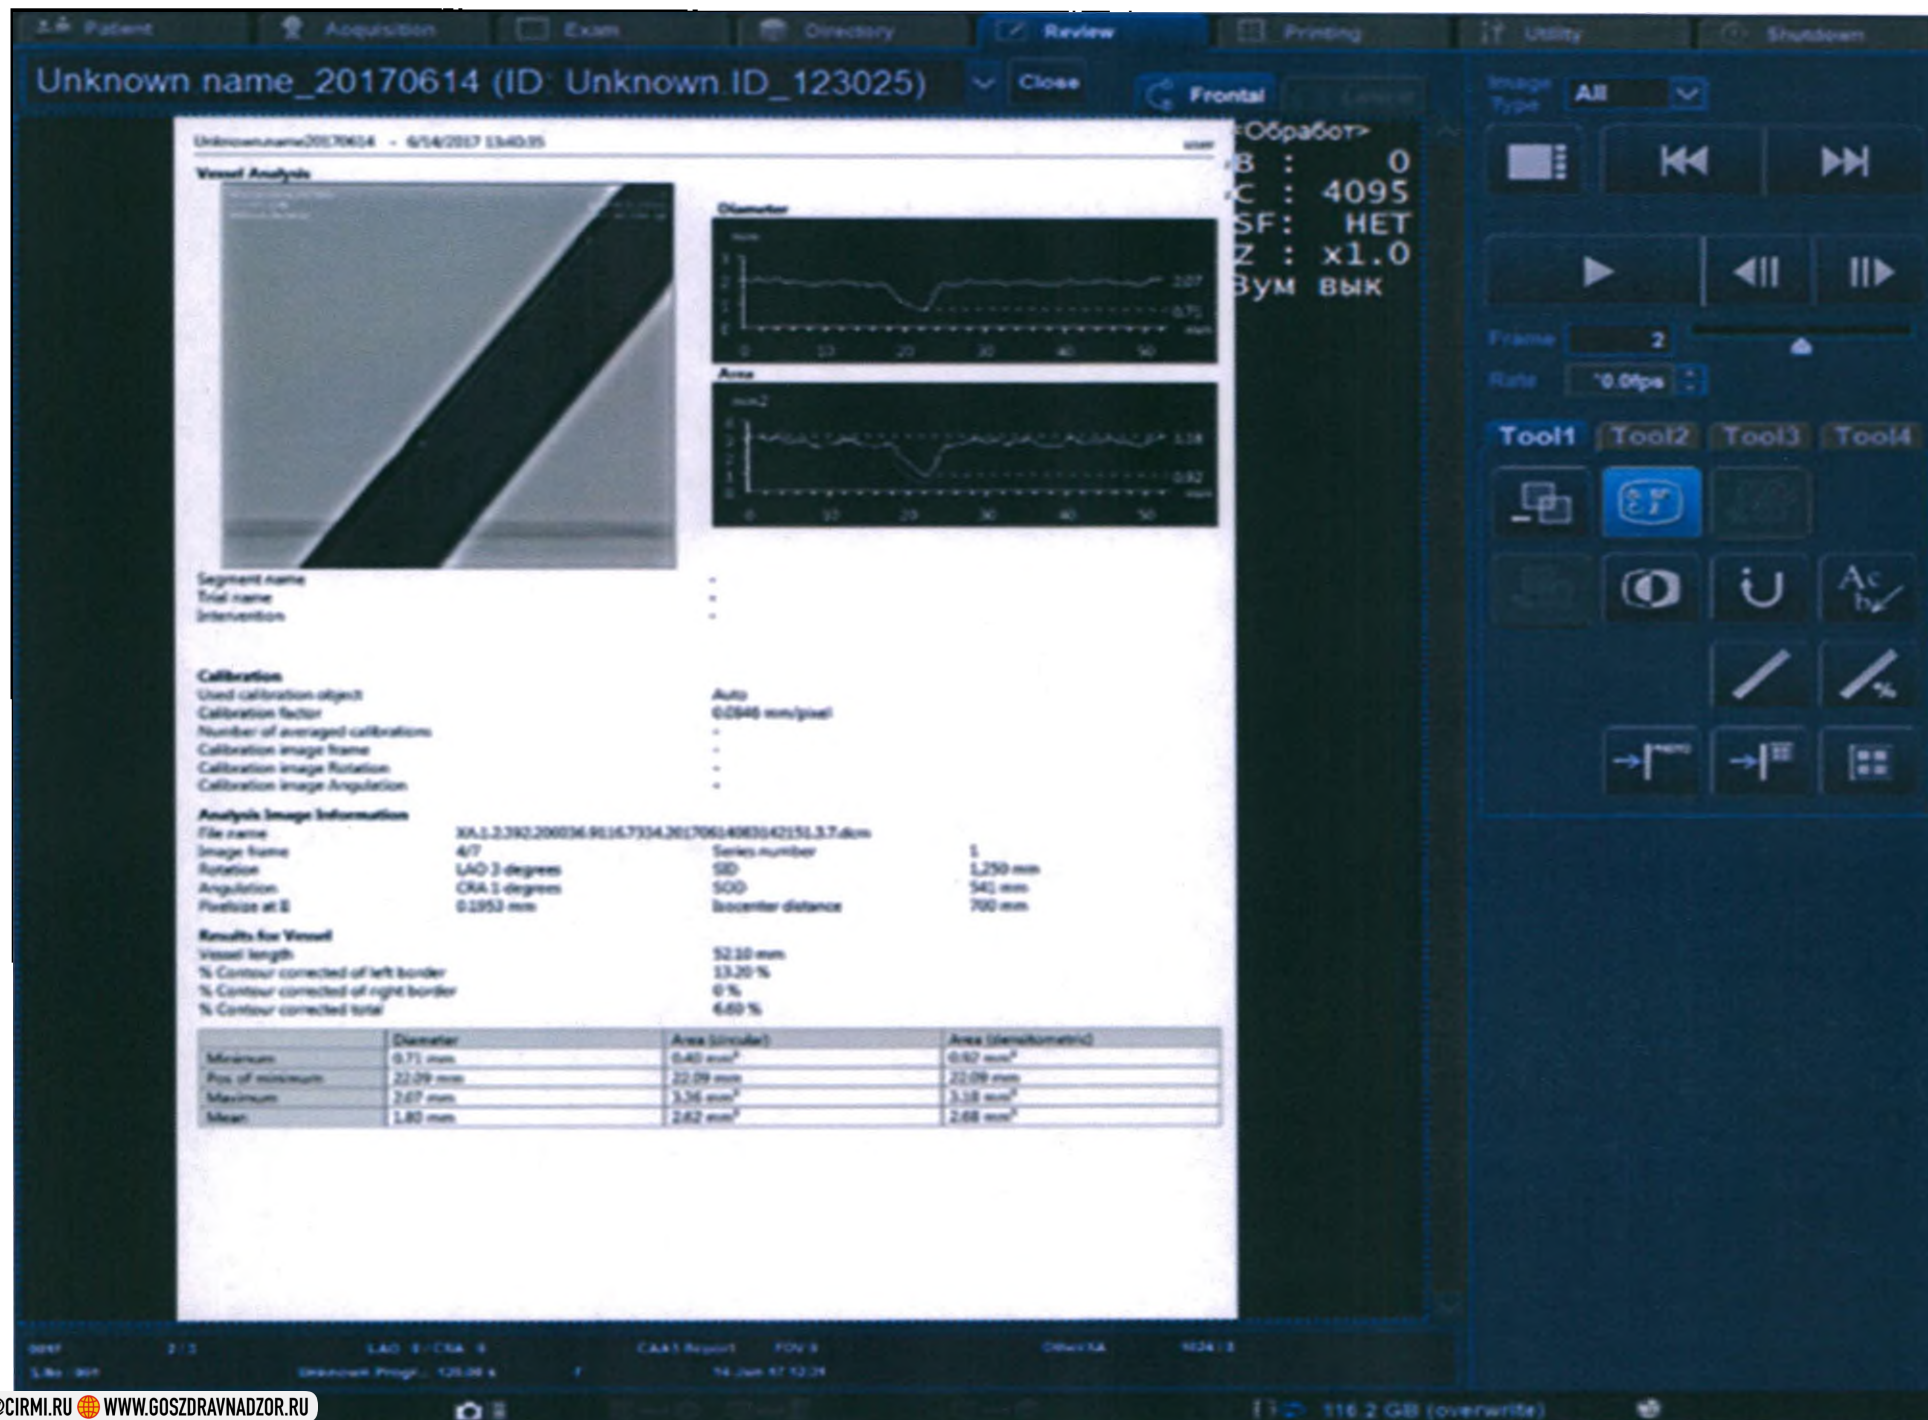

8. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа LVA (анализ левого желудочка)

CAAS Workstation 7.1.1 - 3DAdmin

CAAS

Report
☒ Header Page
 Viewing
☒ QCA 1

Hide image ribbon
 View
 Patient
 QCA
 Stent
 LVA
 RVA
 Report
 Save Report

DRDENKOVA RAISA MIKHAYLOVNA - 15.06.2017

CAAS

DRDENKOVA RAISA MIKHAYLOVNA
 20.03.1948
 Female
 KAZ0170615114027

PIE MEDICAL IMAGING

Report details

CAAS Workstation	3D-ANGIO3DAdmin
Creation date:	15.06.2017 17:11:40
Serial number:	1299932669
Institution name:	MMA n.b. Sechenov
Institution address:	68.PirogovskayaMoscowMoscow121120Russian Federation
Department name:	Department

Patient Information

Name:	DRDENKOVA RAISA MIKHAYLOVNA	Height:	167 cm
ID:	37 478/2017	Weight:	110 kg
Sex:	Female	BSA:	2.16 m ²
Birthdate (age):	20.03.1948 (69)	Referring physician:	

Comments


Clinical history

Conclusion


CAAS Workstation 7.1.1

1 / 2


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа LVA-ВР (двухплоскостной анализ левого желудочка)

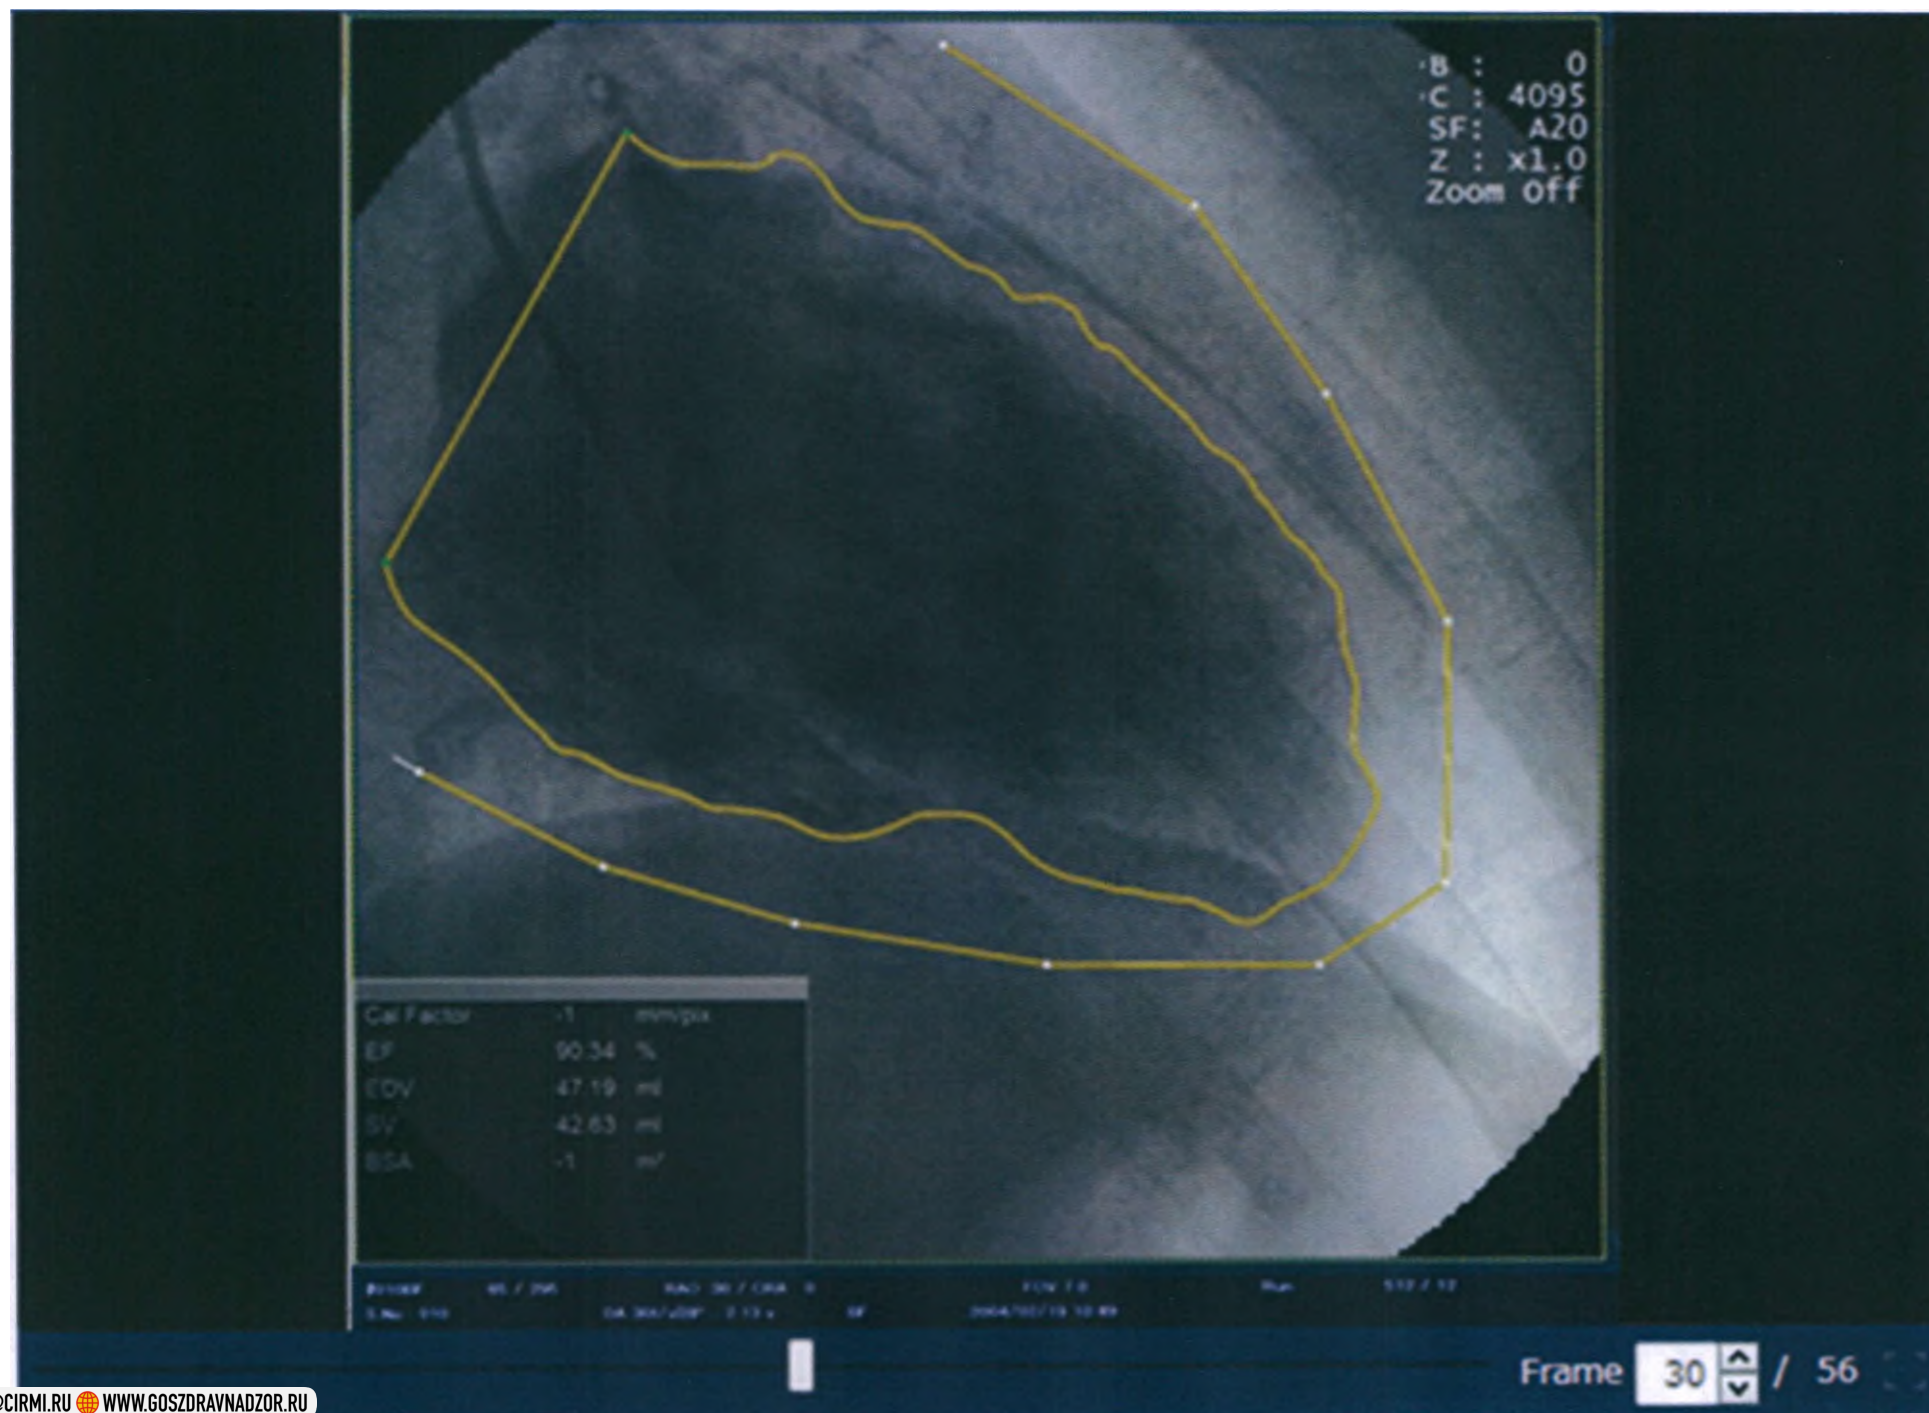


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа RVA (анализ правого желудочка)

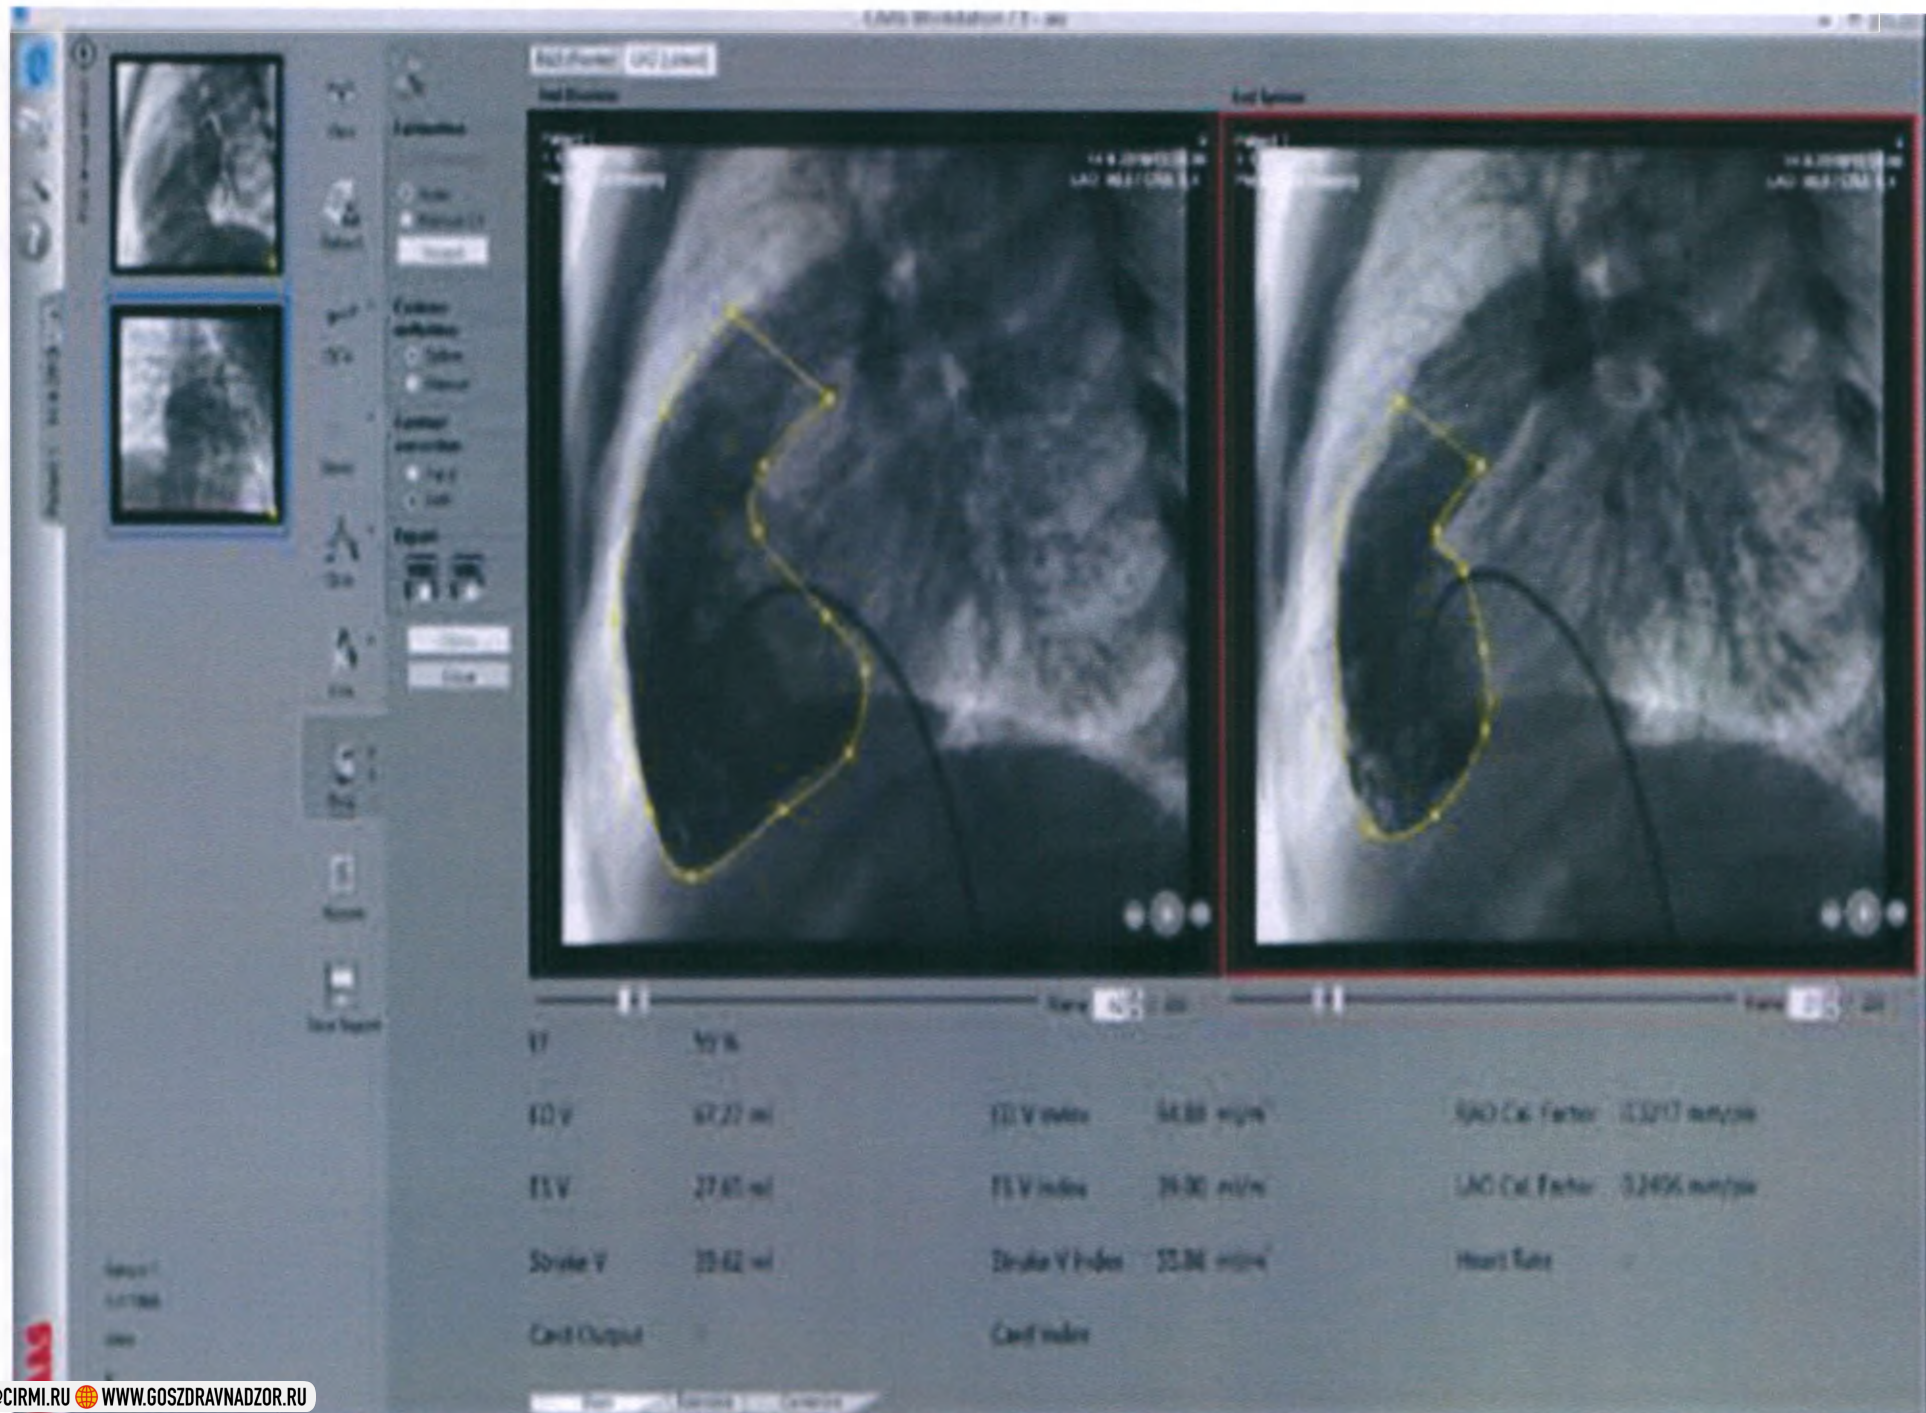


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа QCA3D (3D-анализ коронарных артерий)

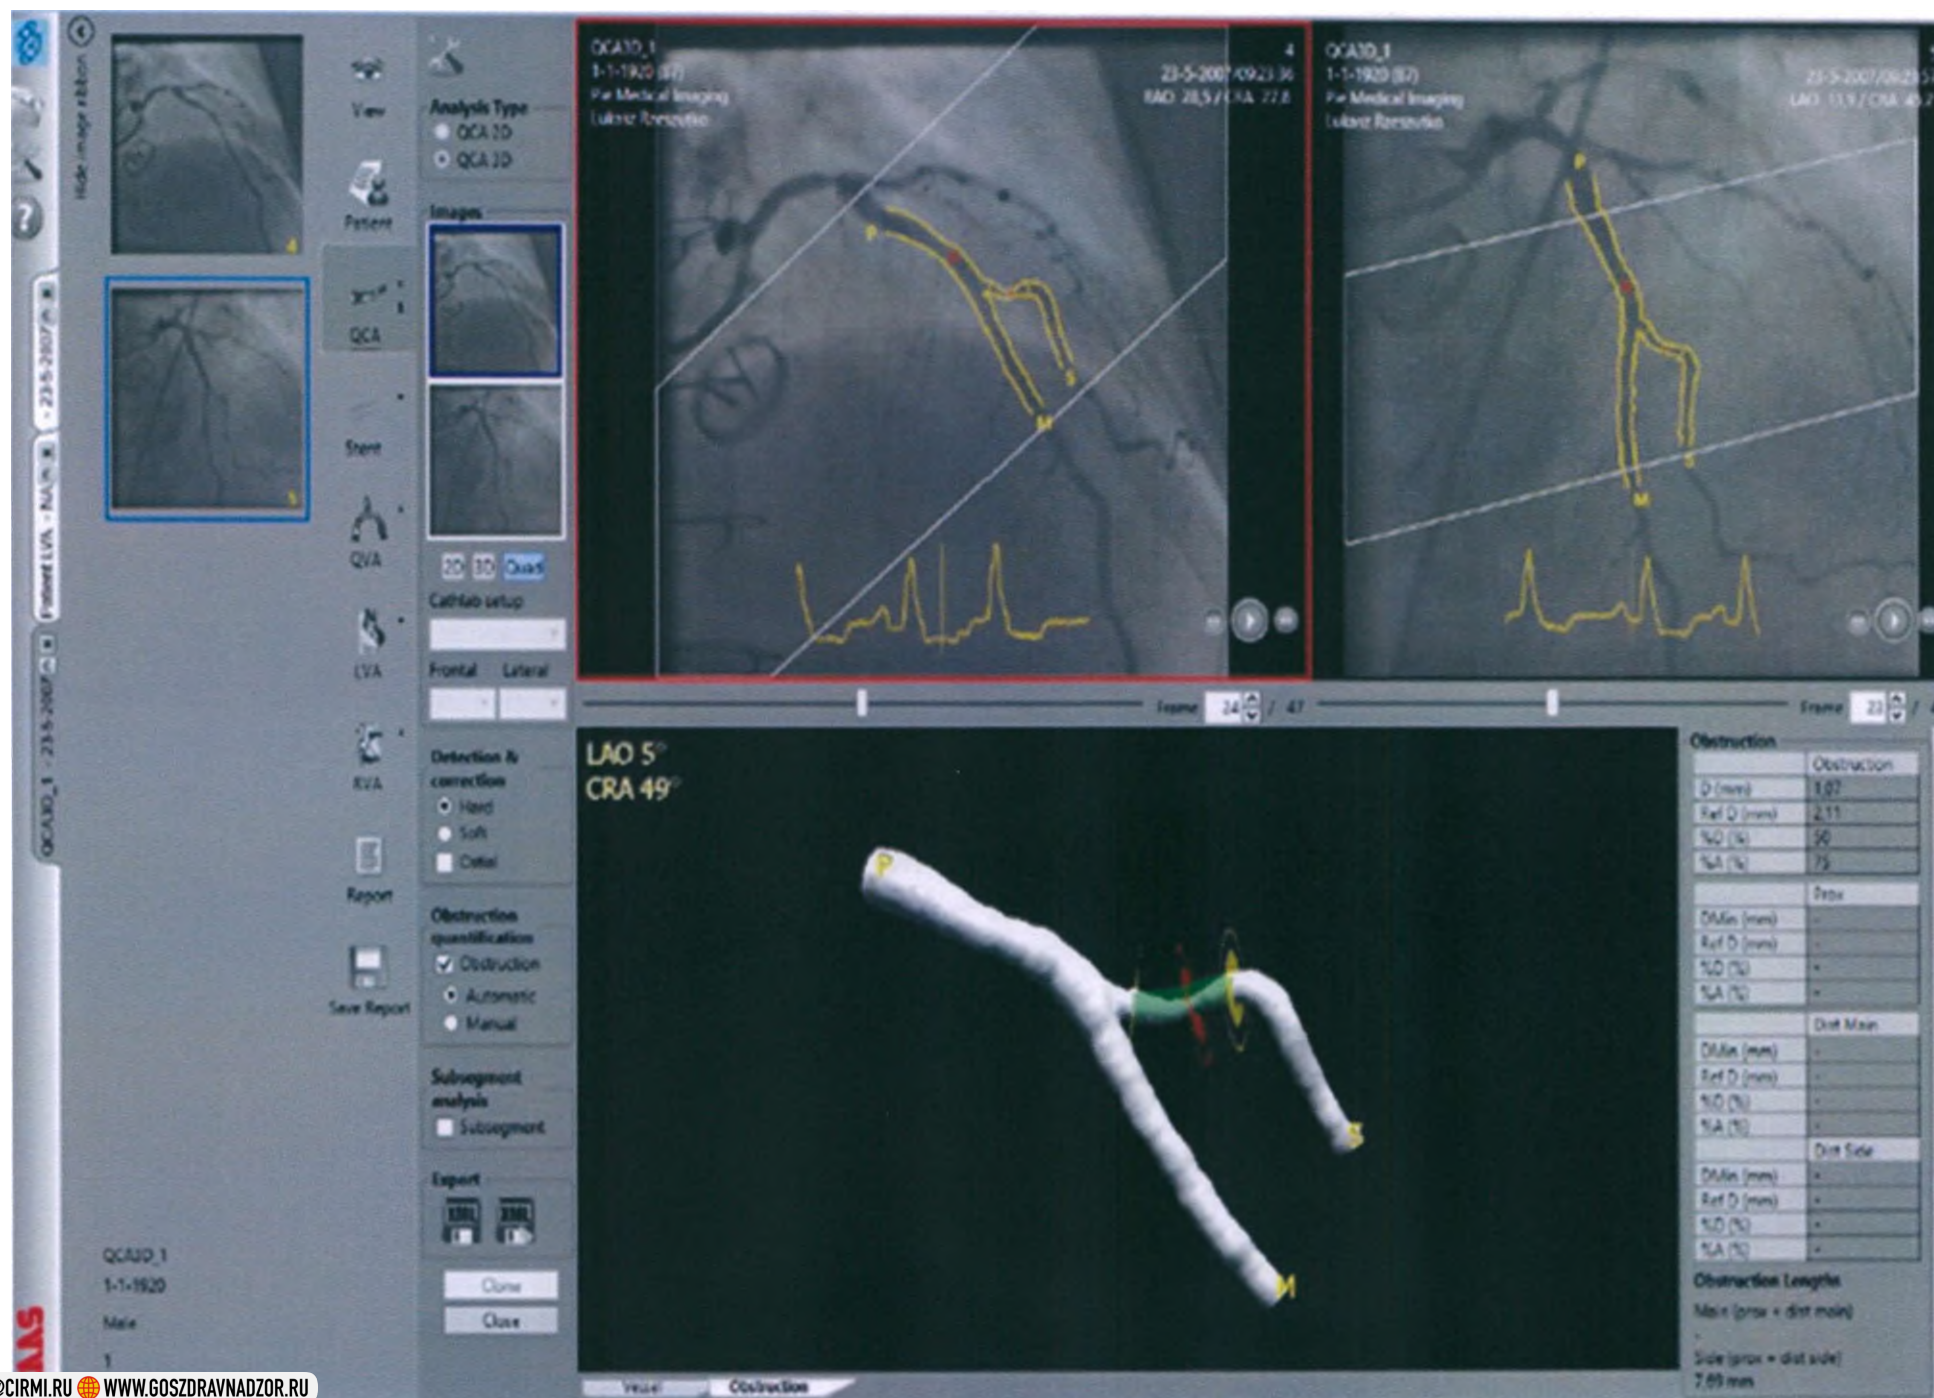


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа Stent Enhancer (отображение с контрастированием стента) .

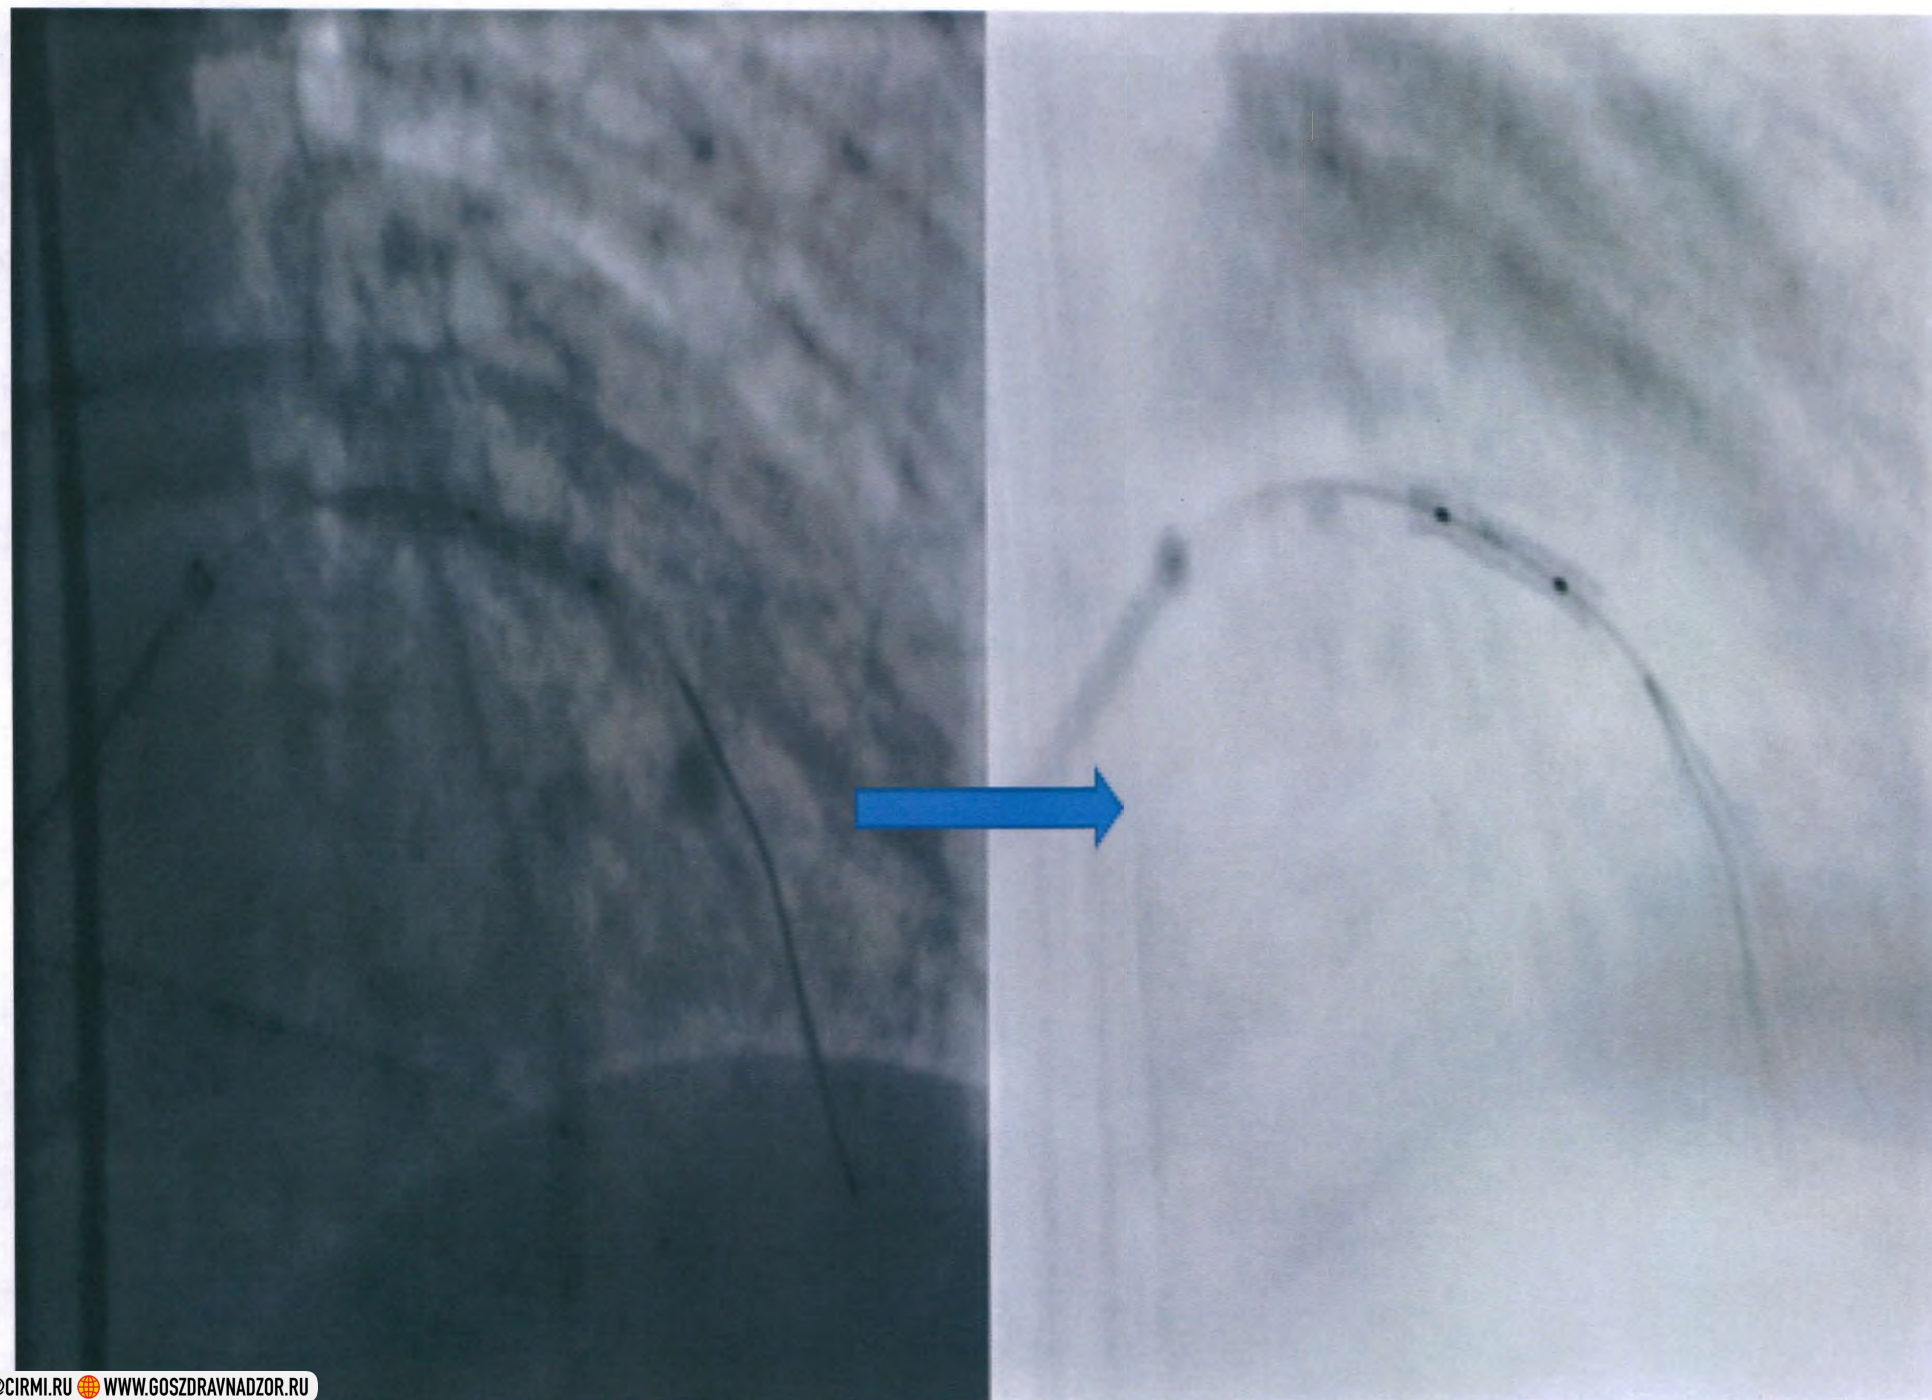

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для клинического анализа IV-LINQ (одновременная регистрация рентгеновских изображений и изображений ВСУЗИ/ОКТ)

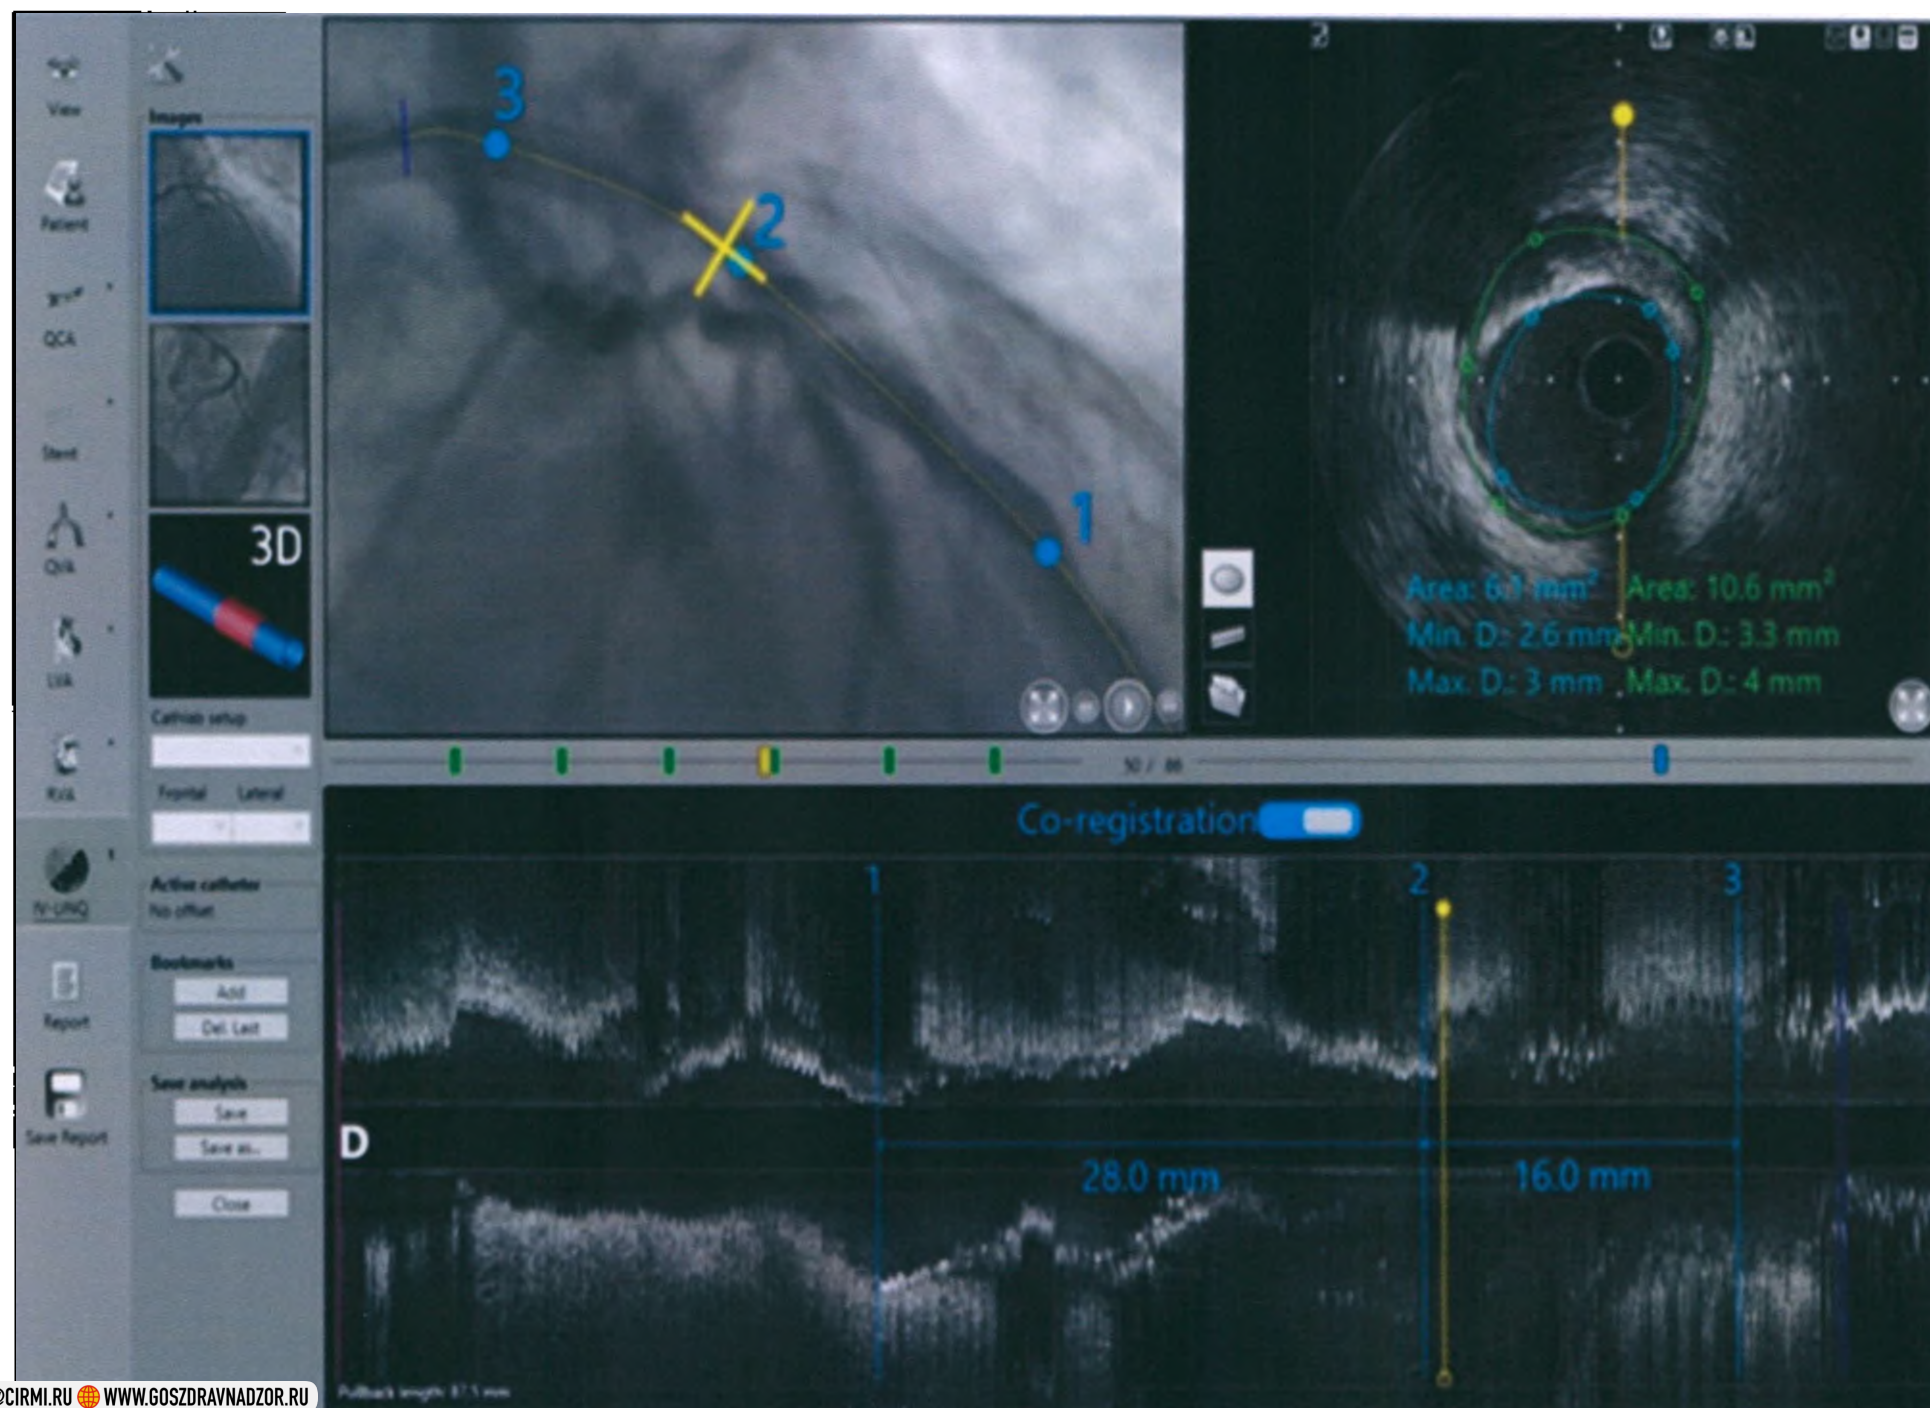


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для 3D-картирования;

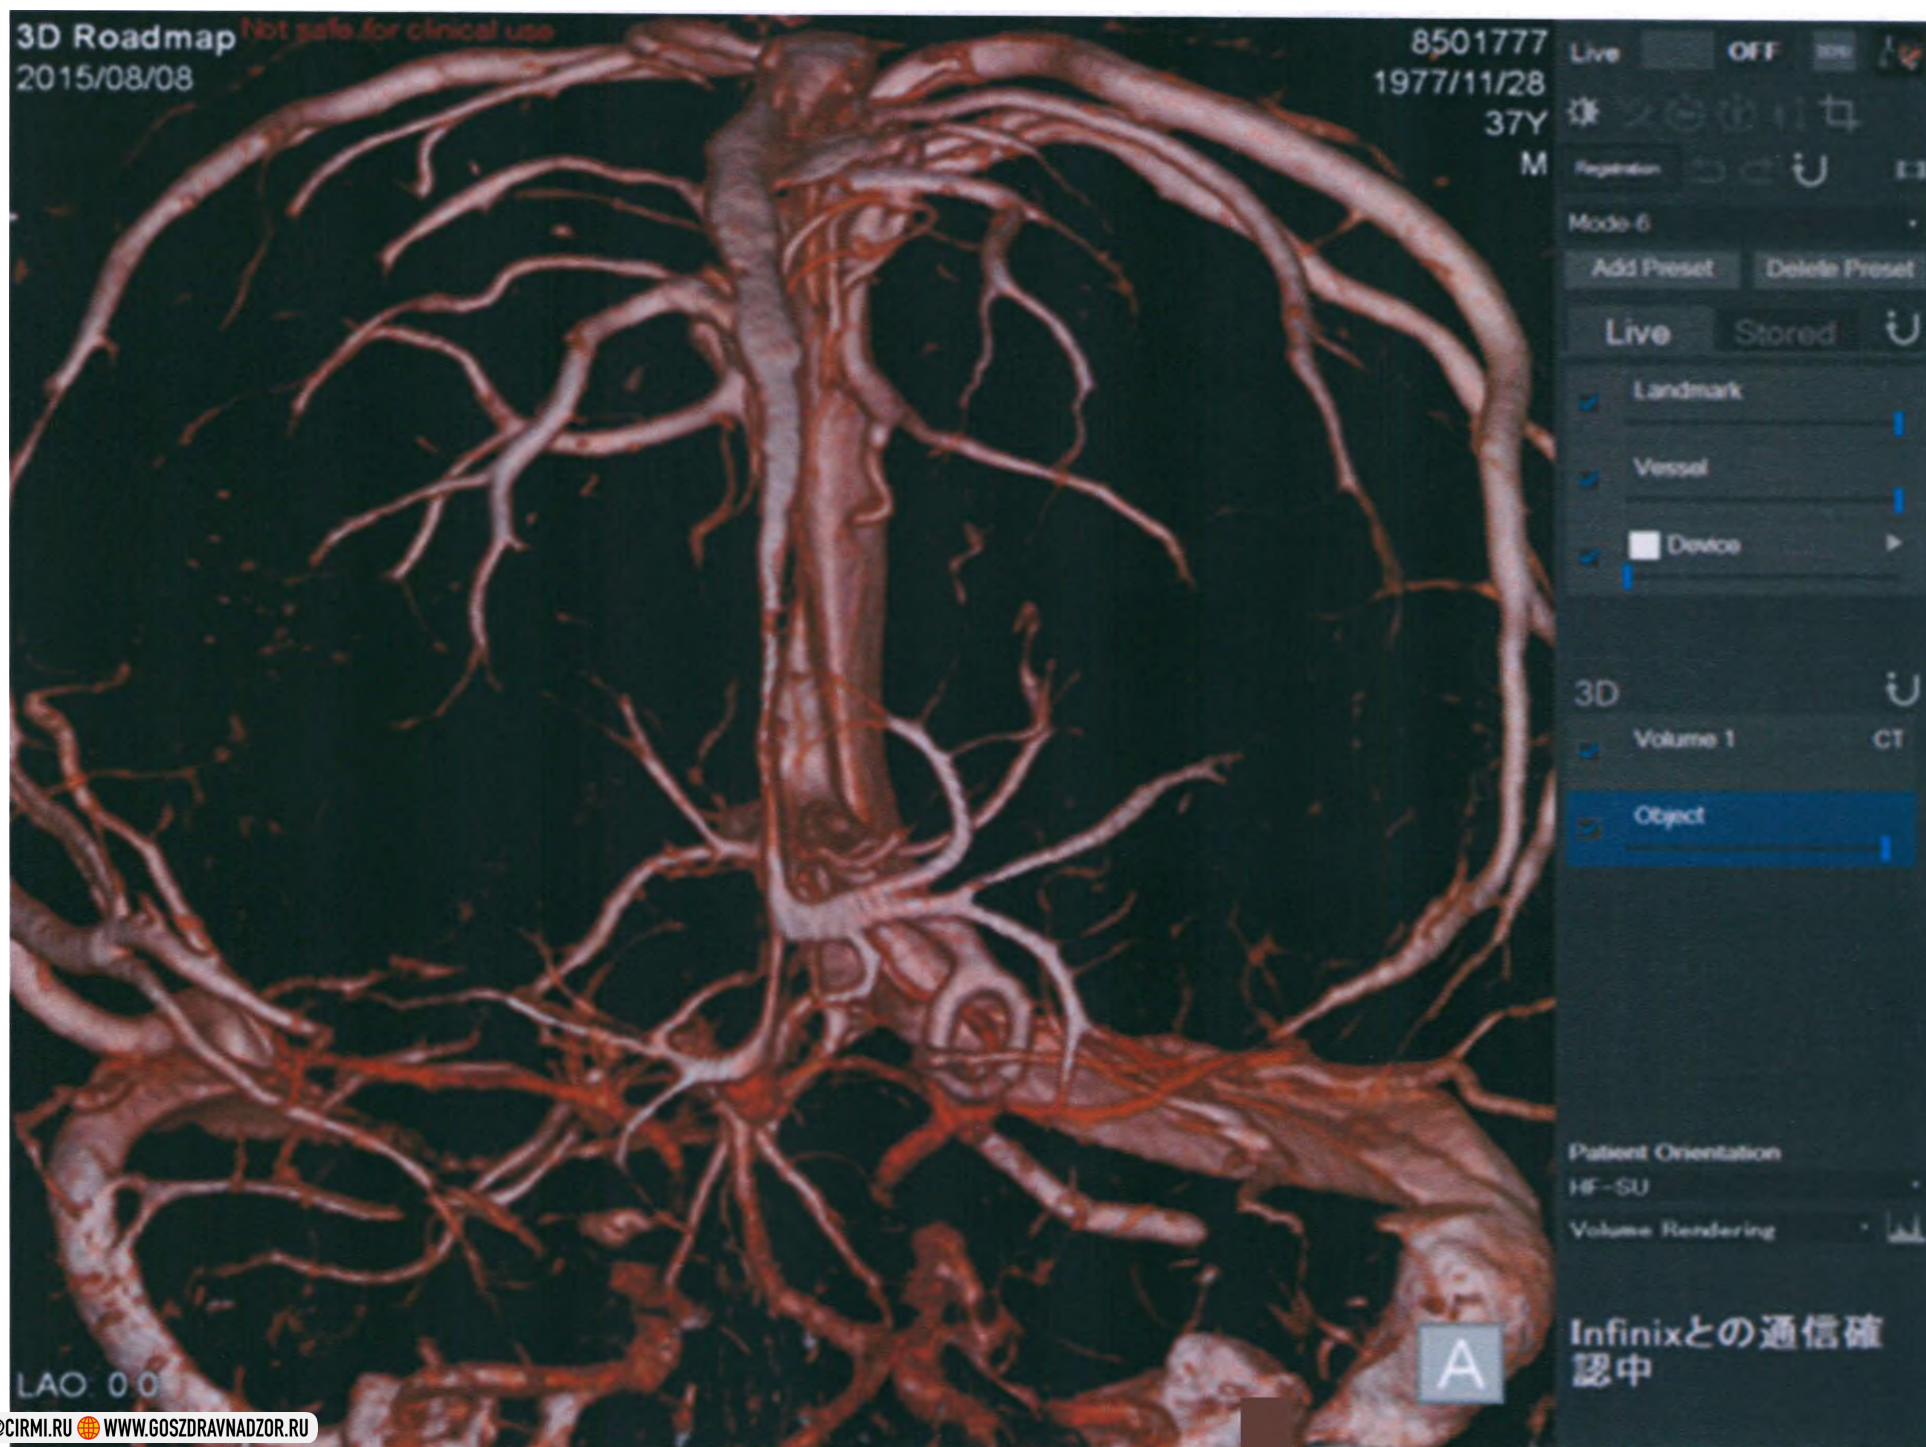


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для мультимодального картирования;




89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для поддержки TAVR (3mensio);

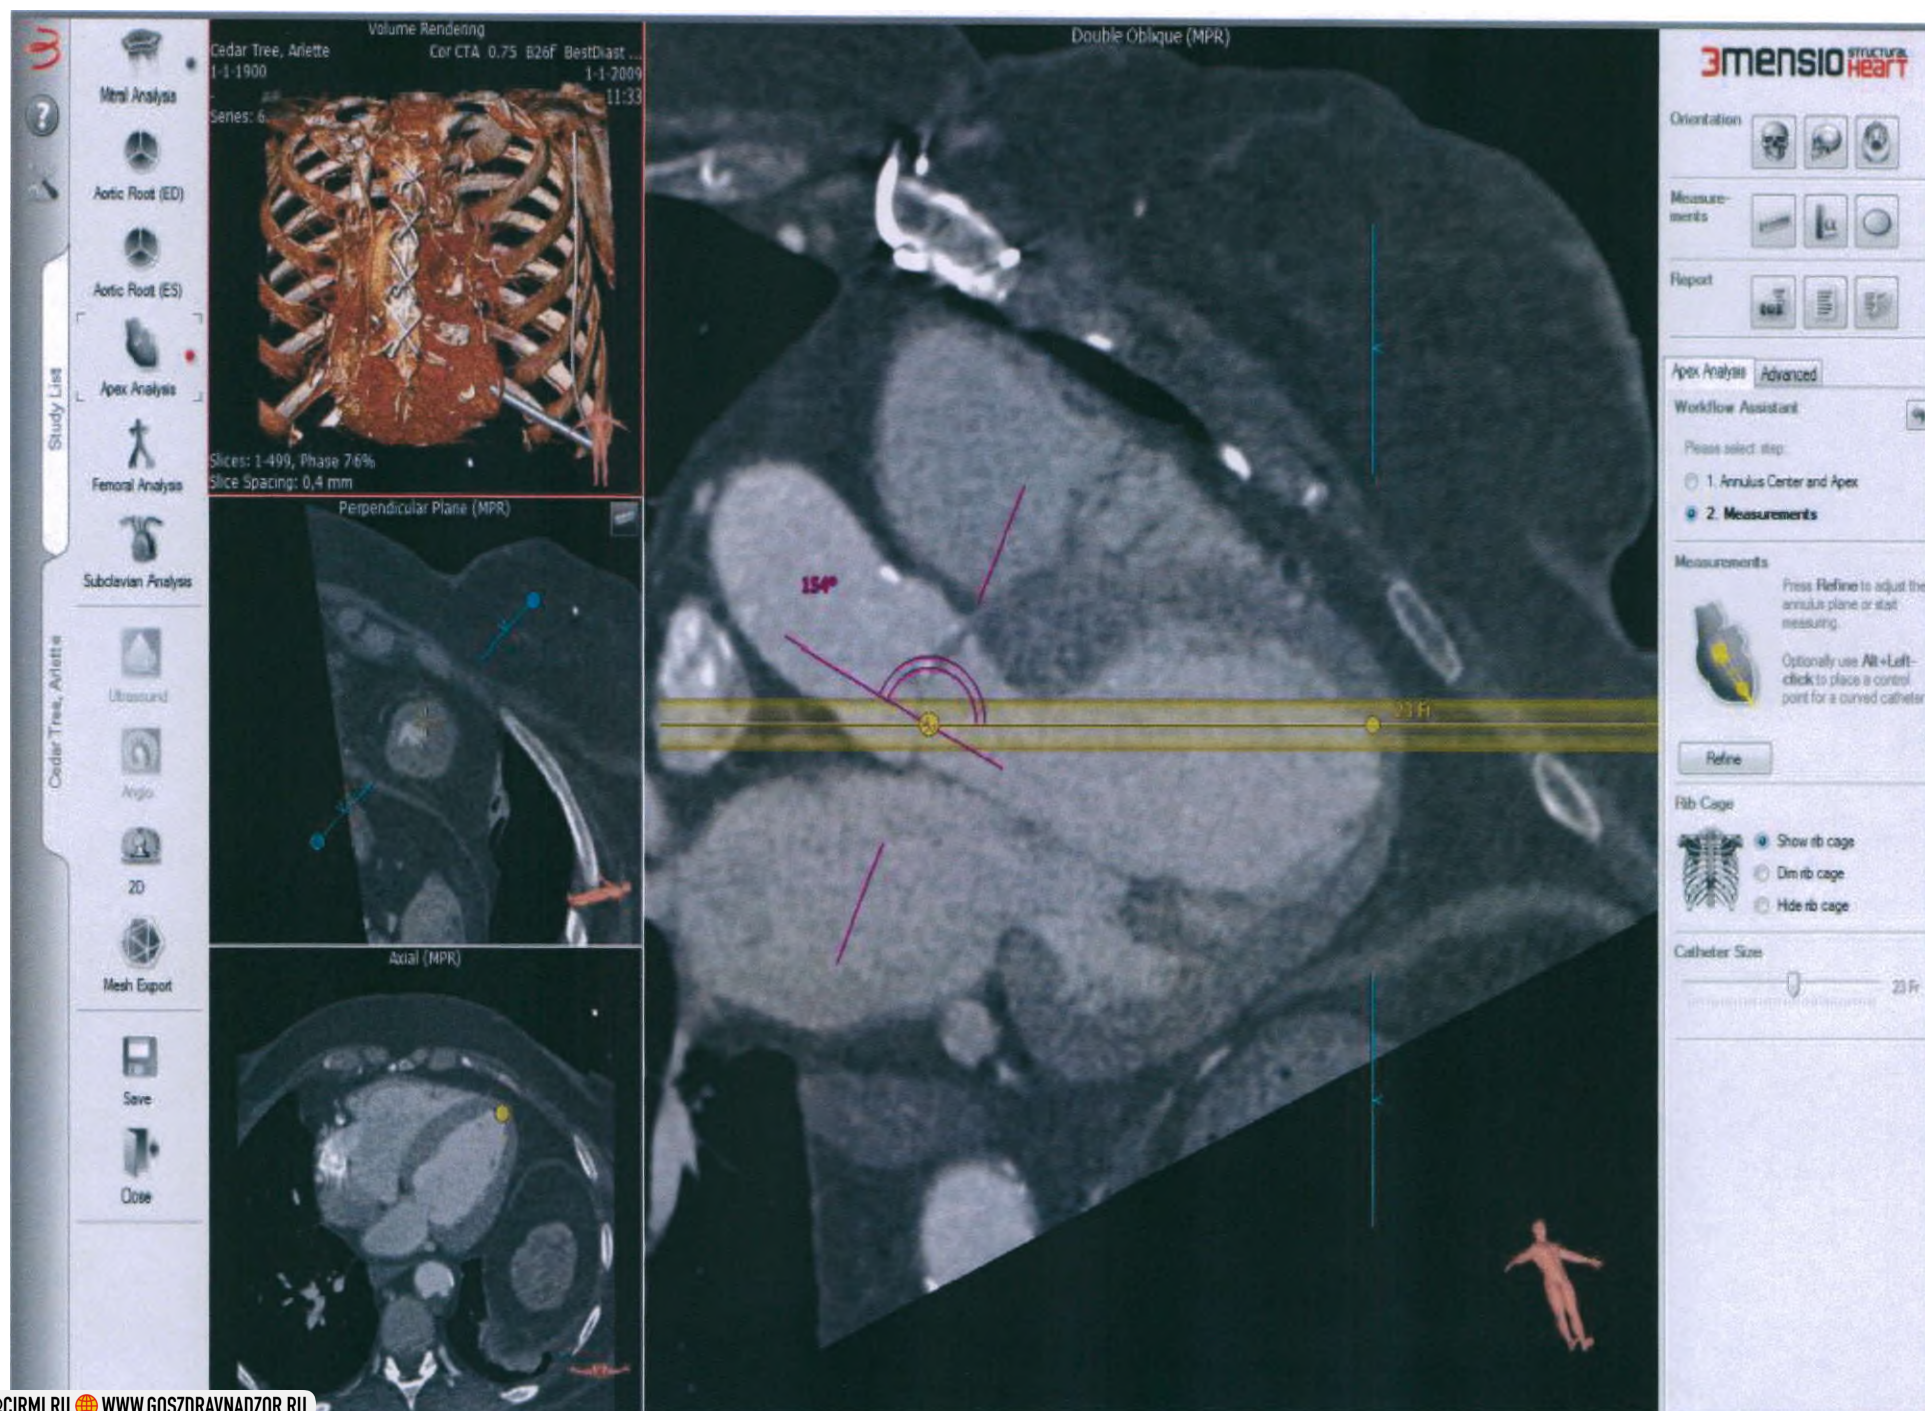


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для поддержки TAVR (3mensio и CAAS A-Valve);

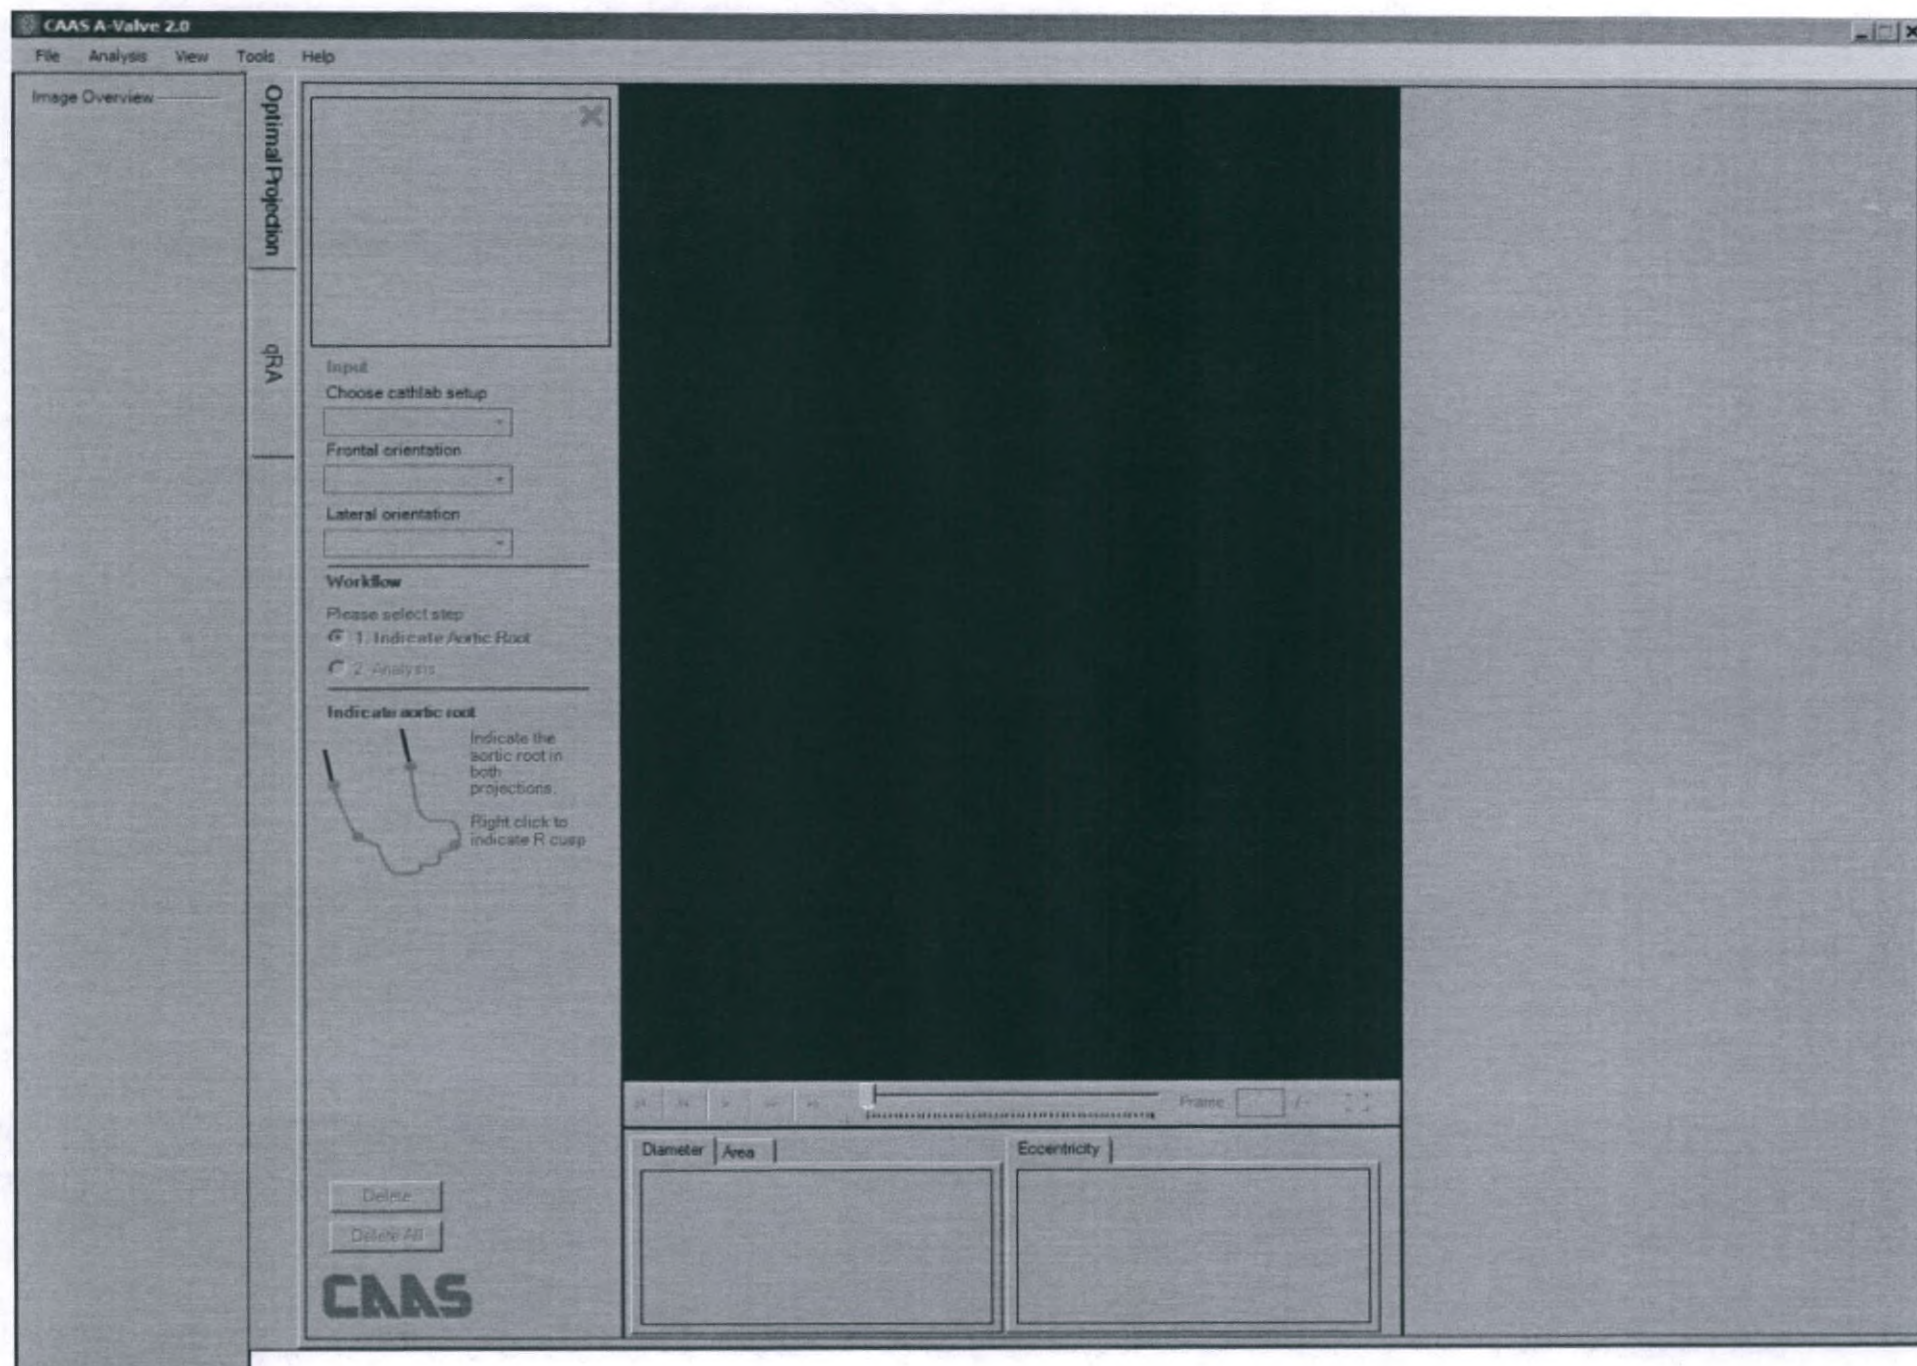


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа митрального клапана;

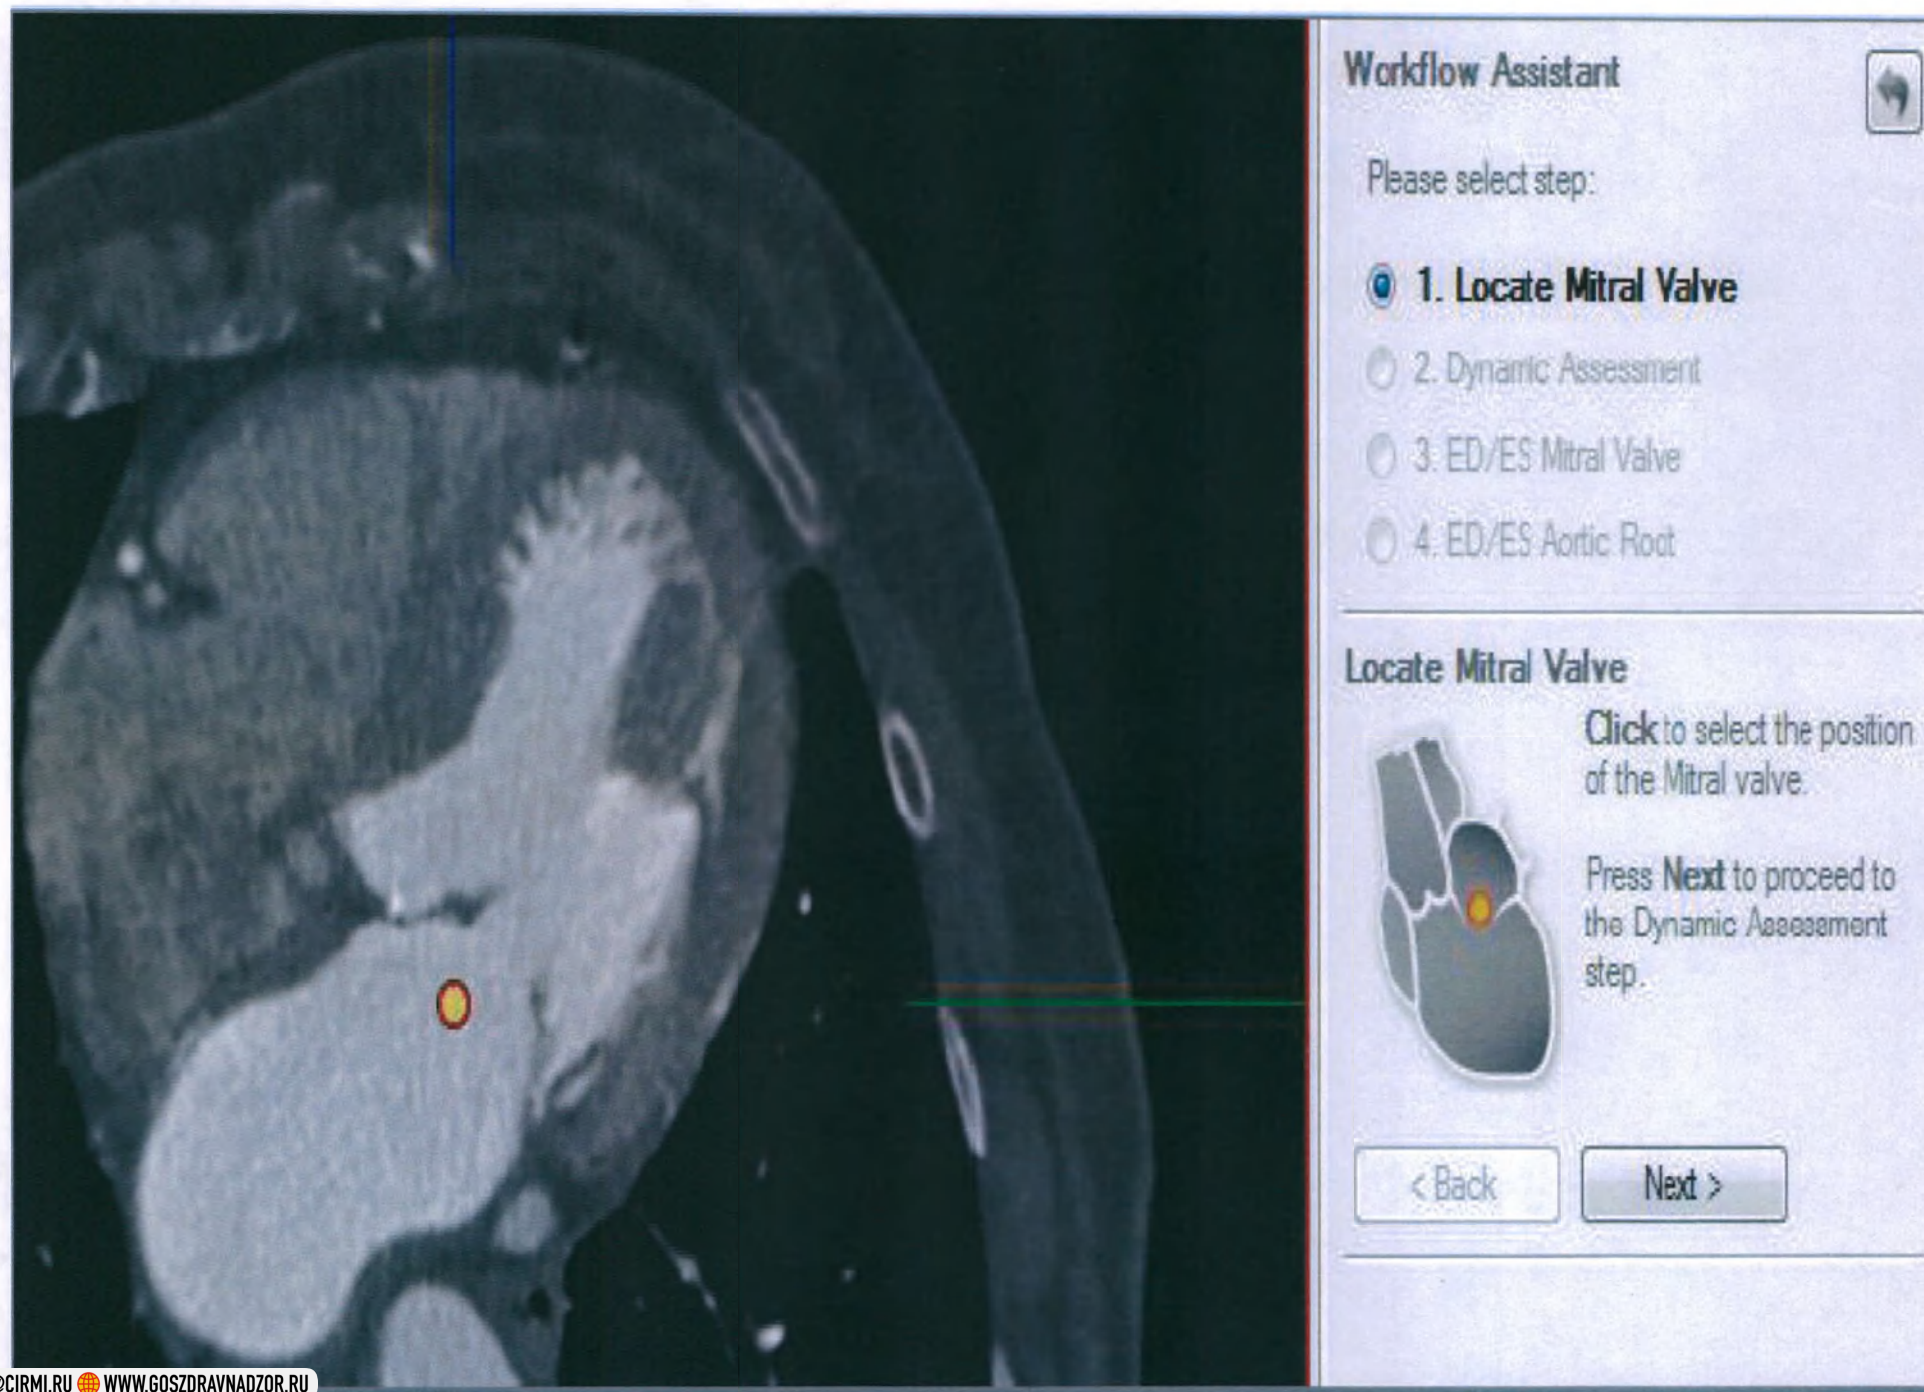


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа ушка левого предсердия;

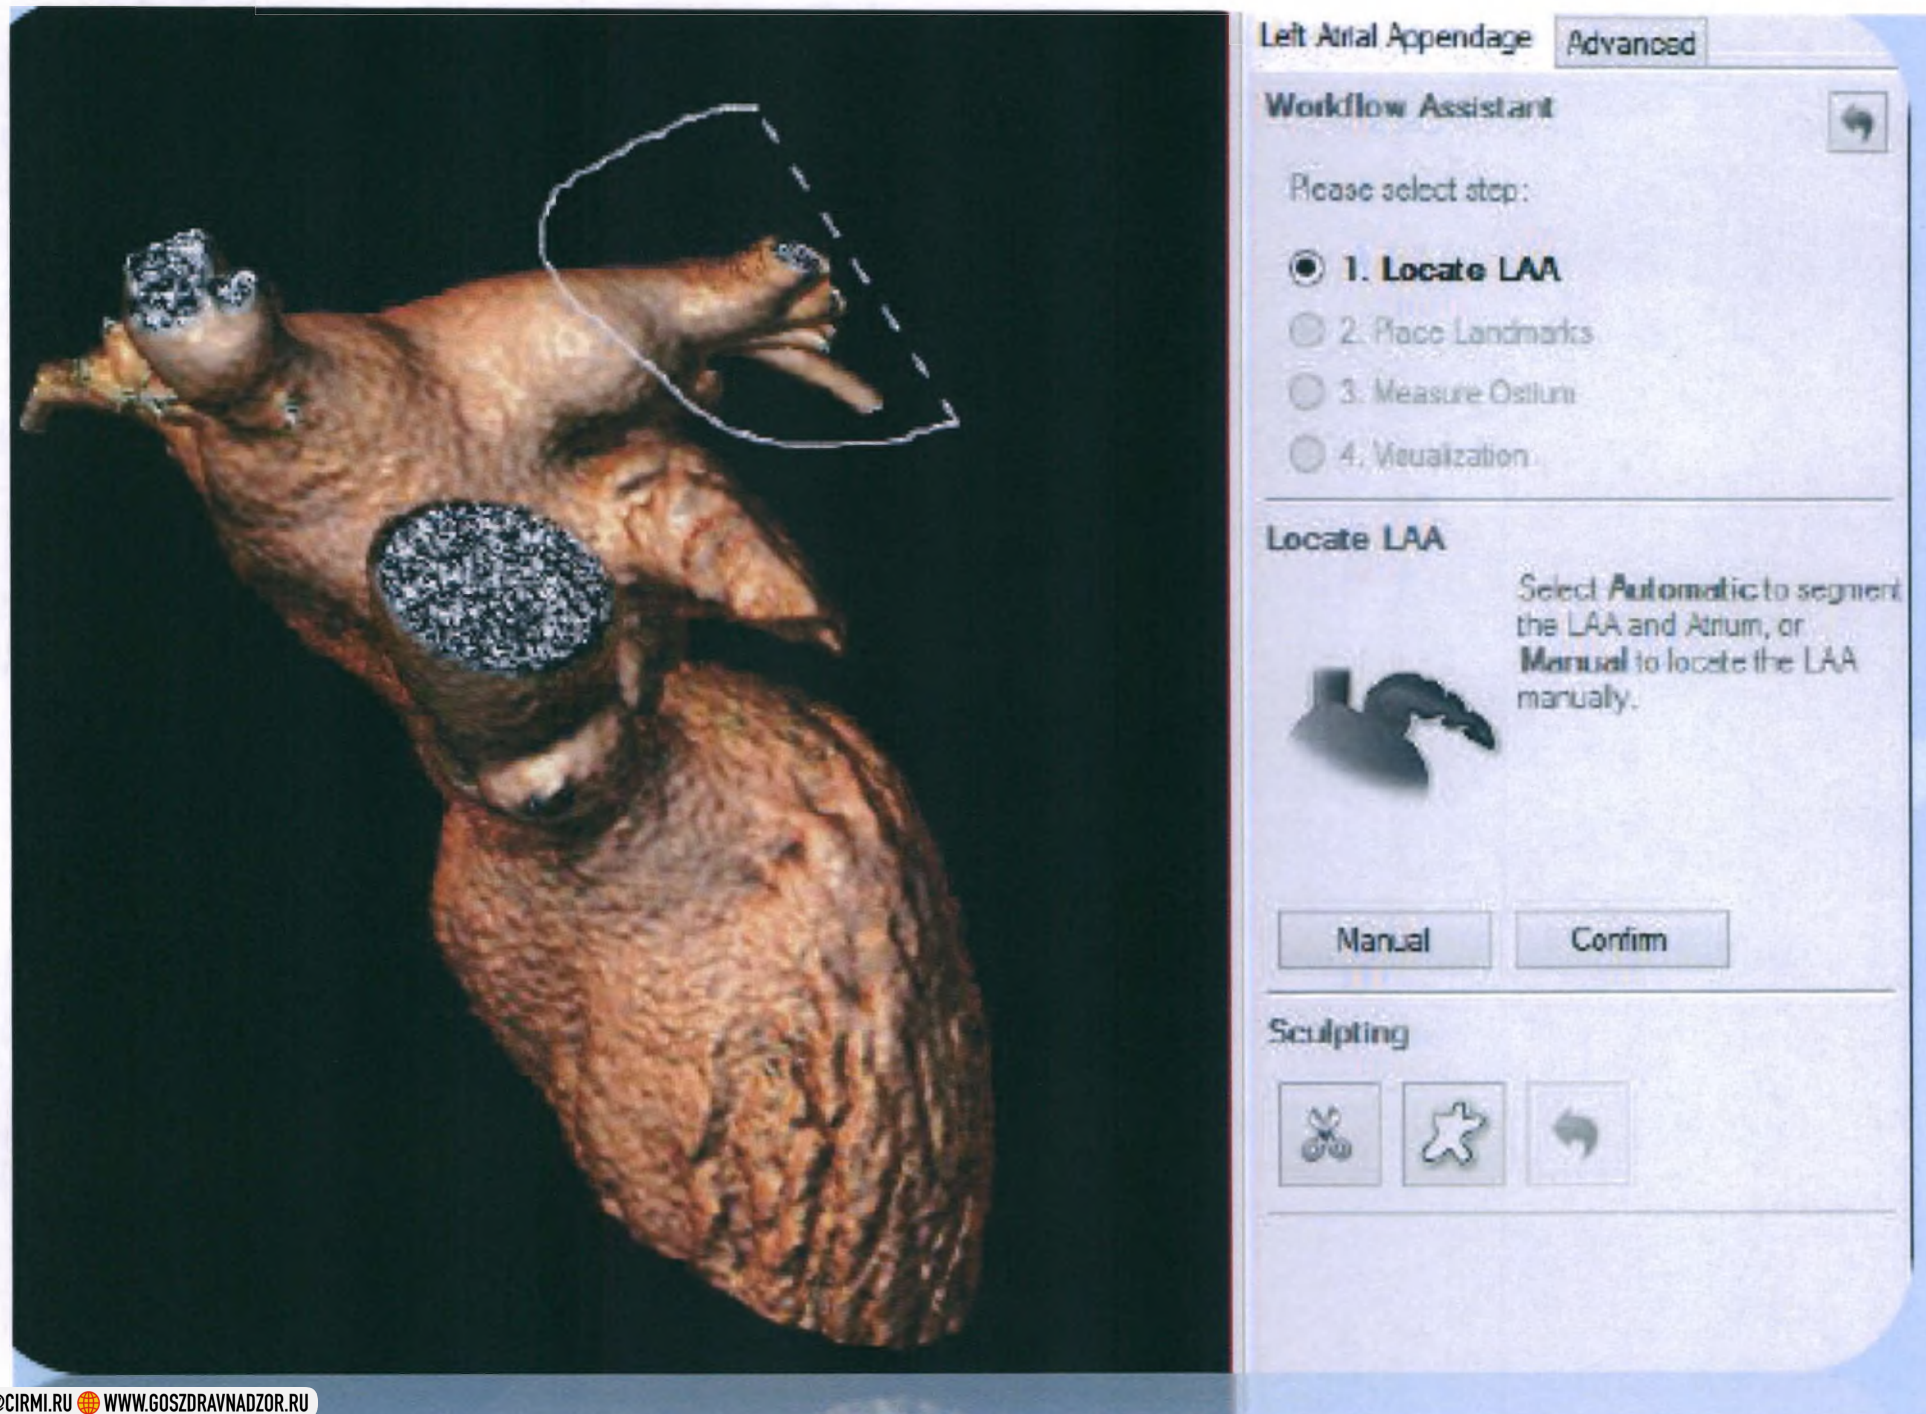

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа регургитации;

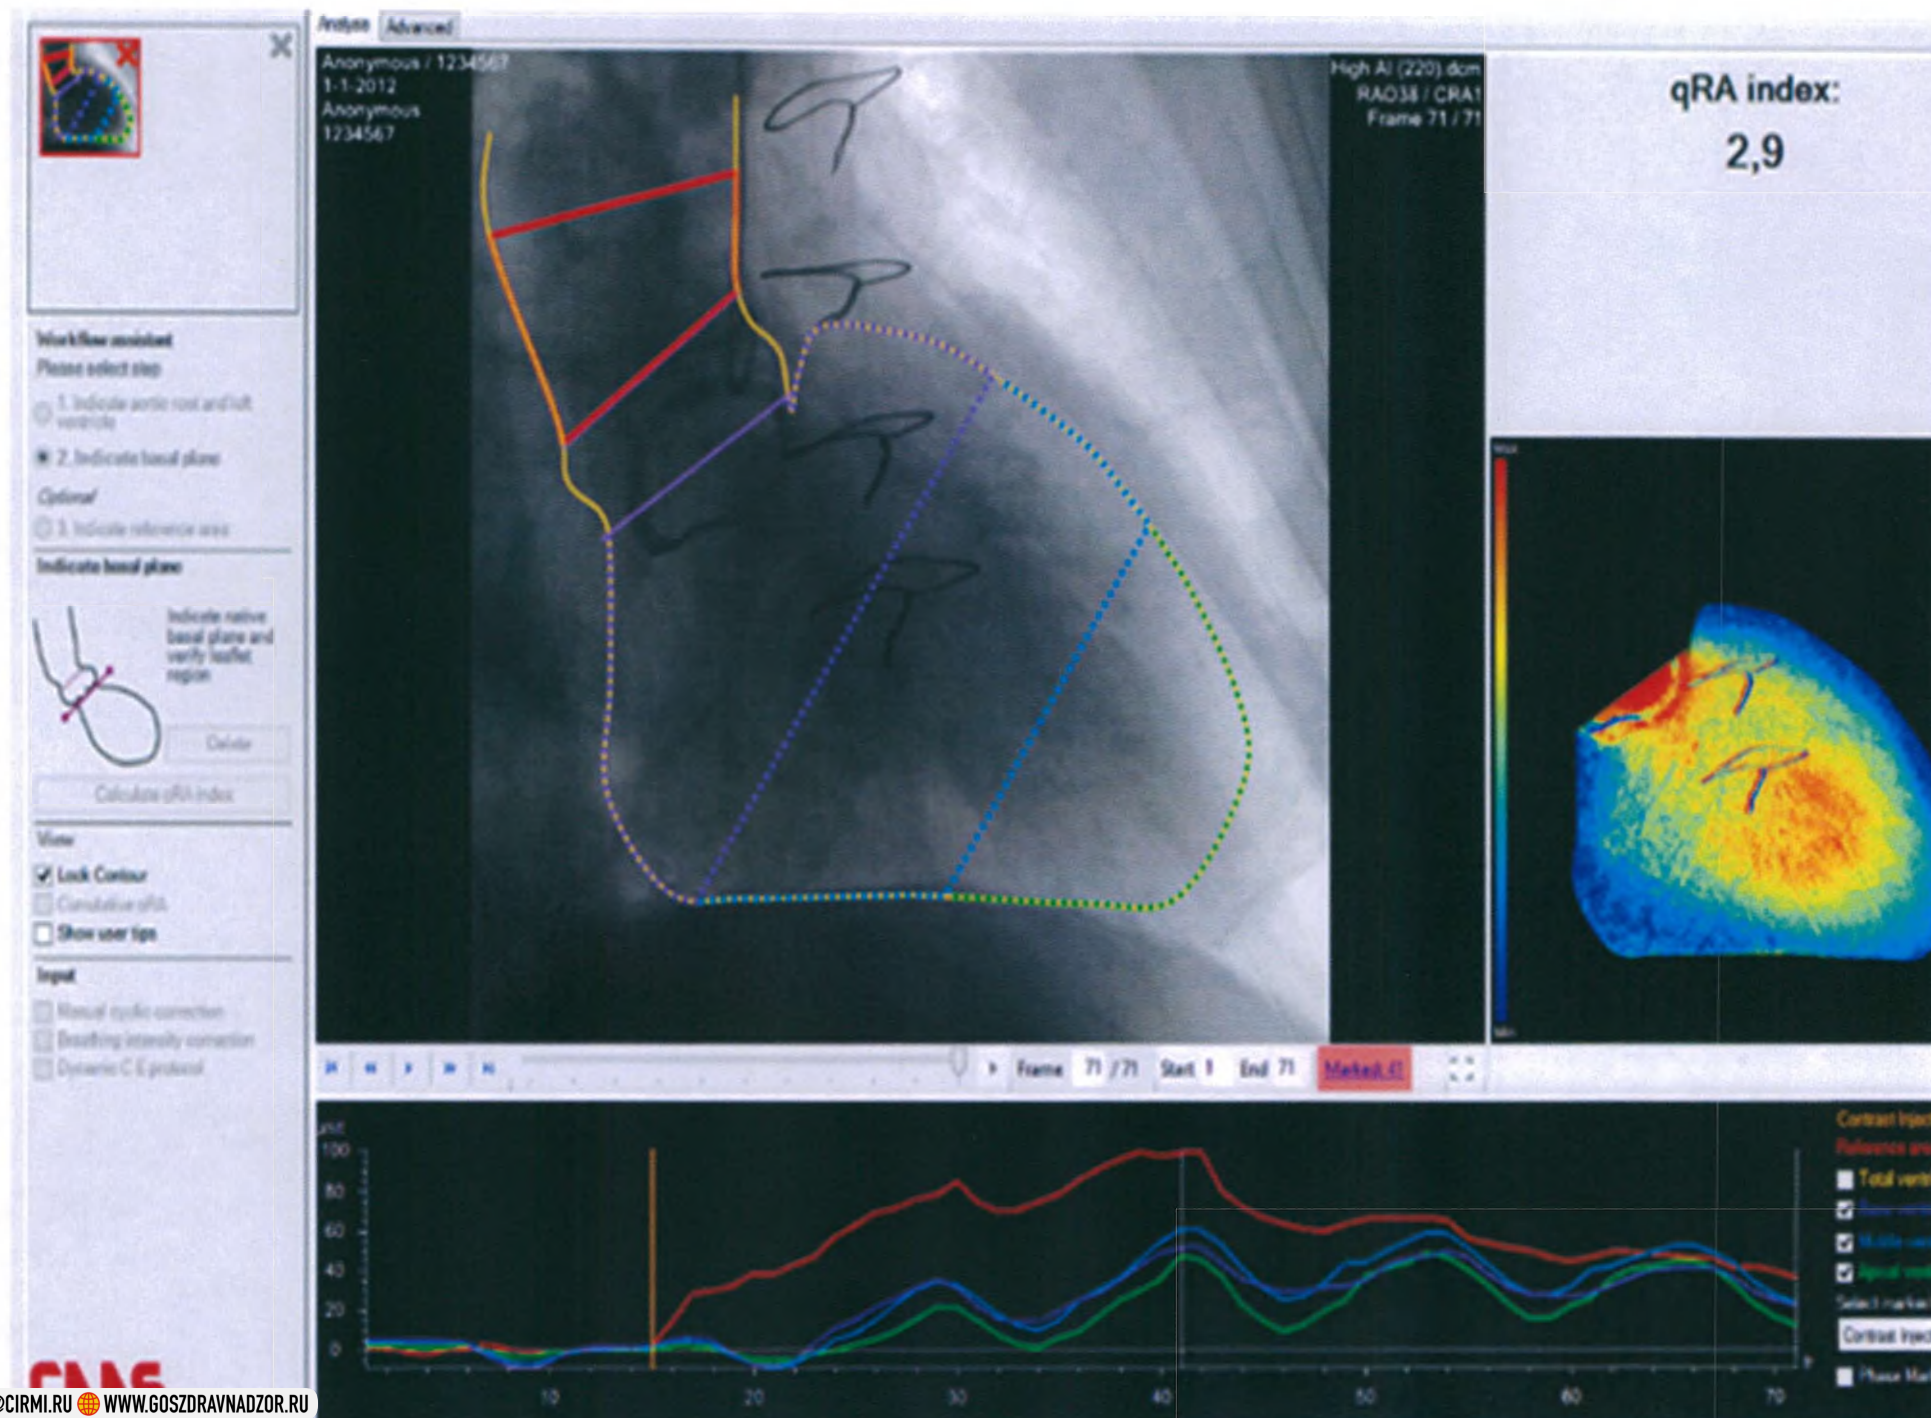


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет DTS для отслеживания дозы;

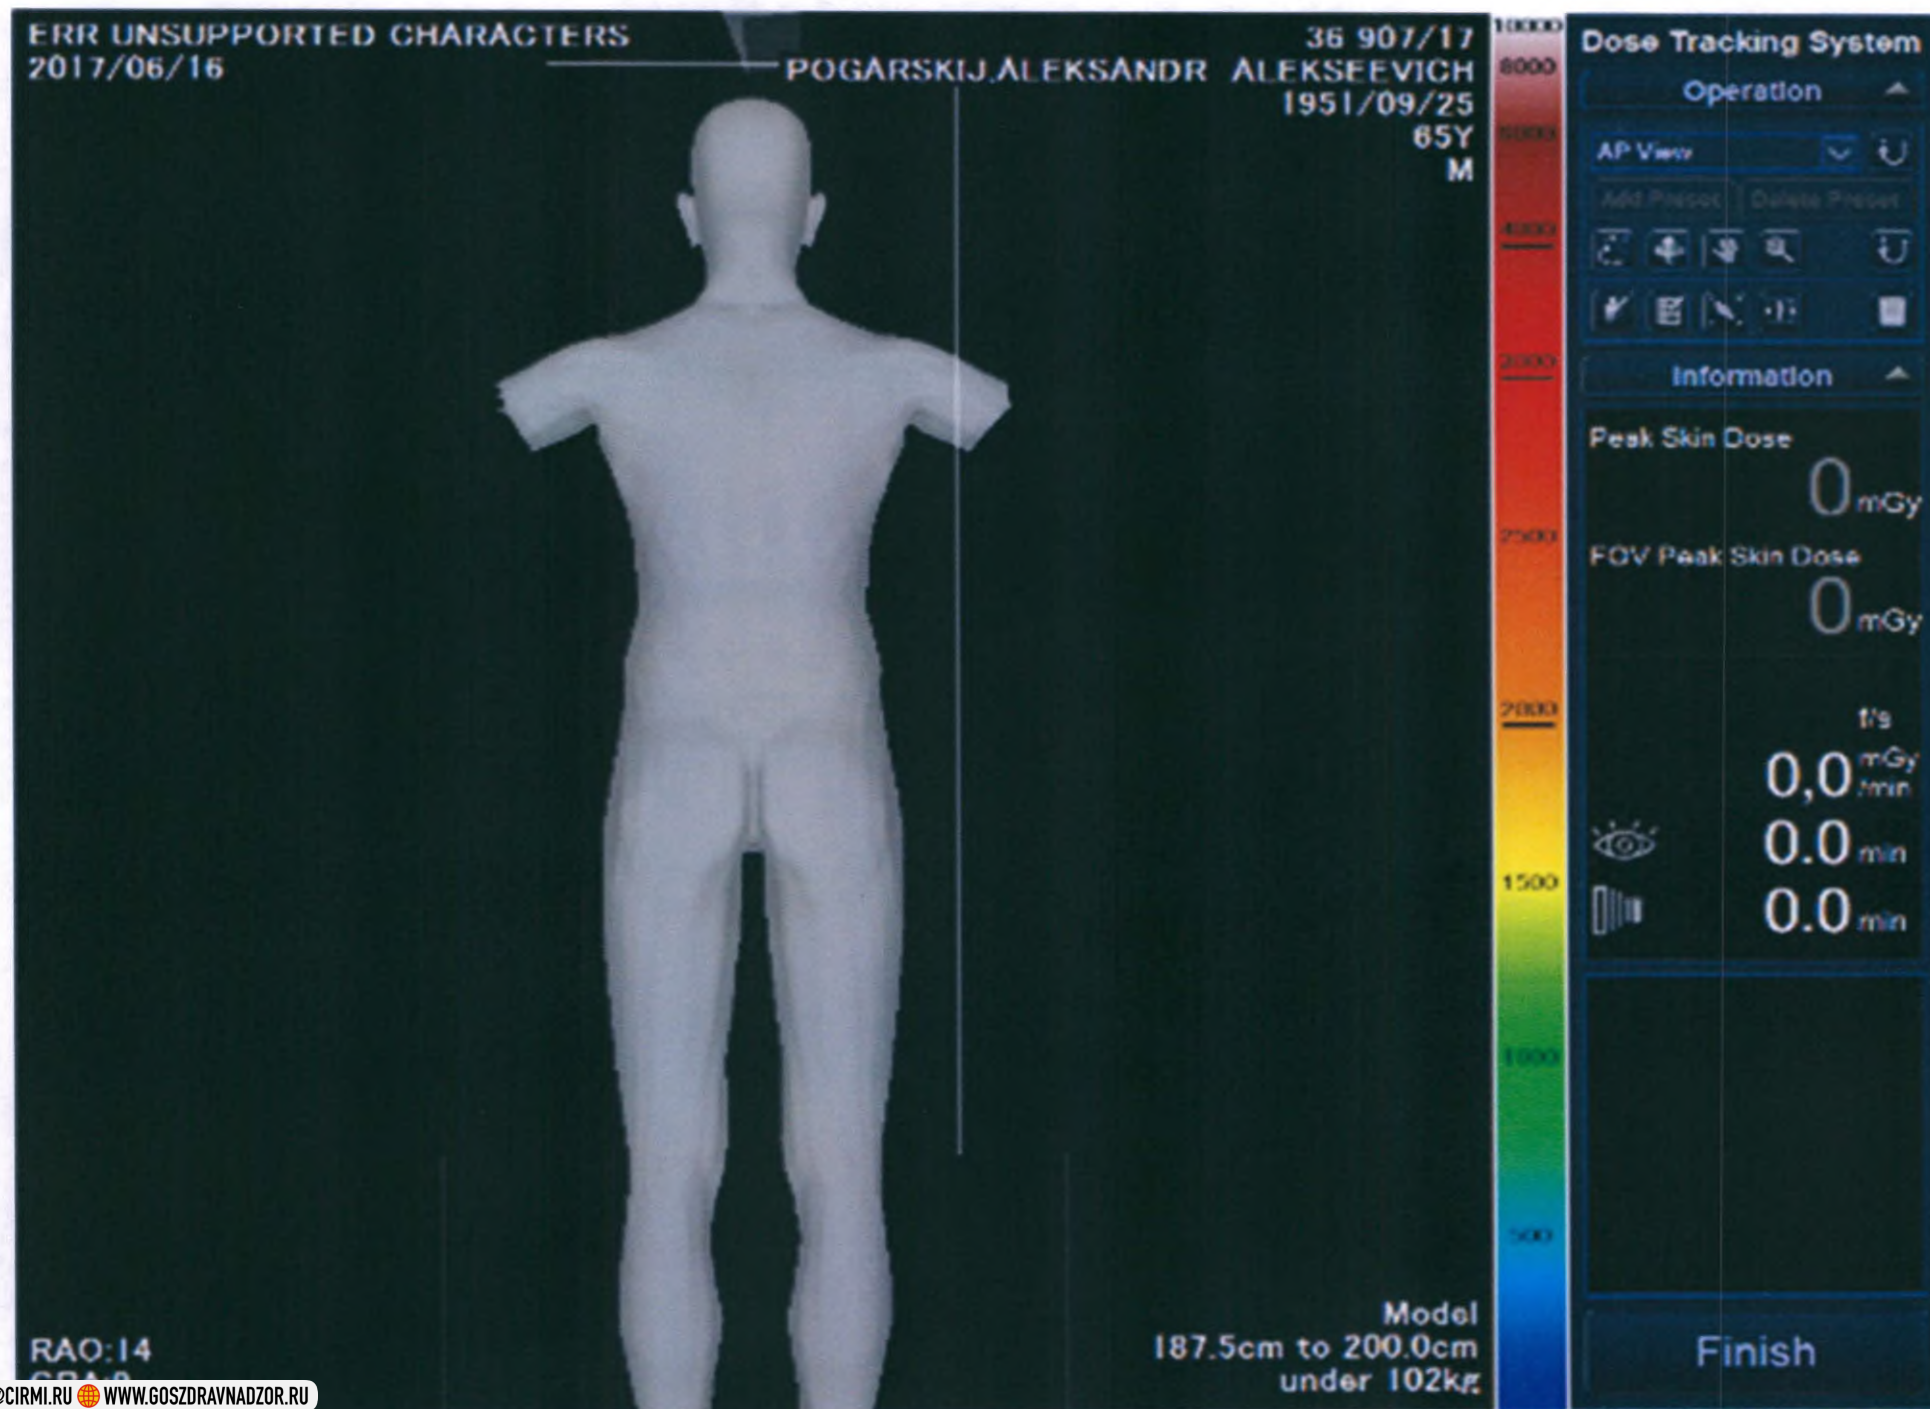

89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет динамической стабилизации устройства;



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для анализа аневризмы сосудов головного мозга;

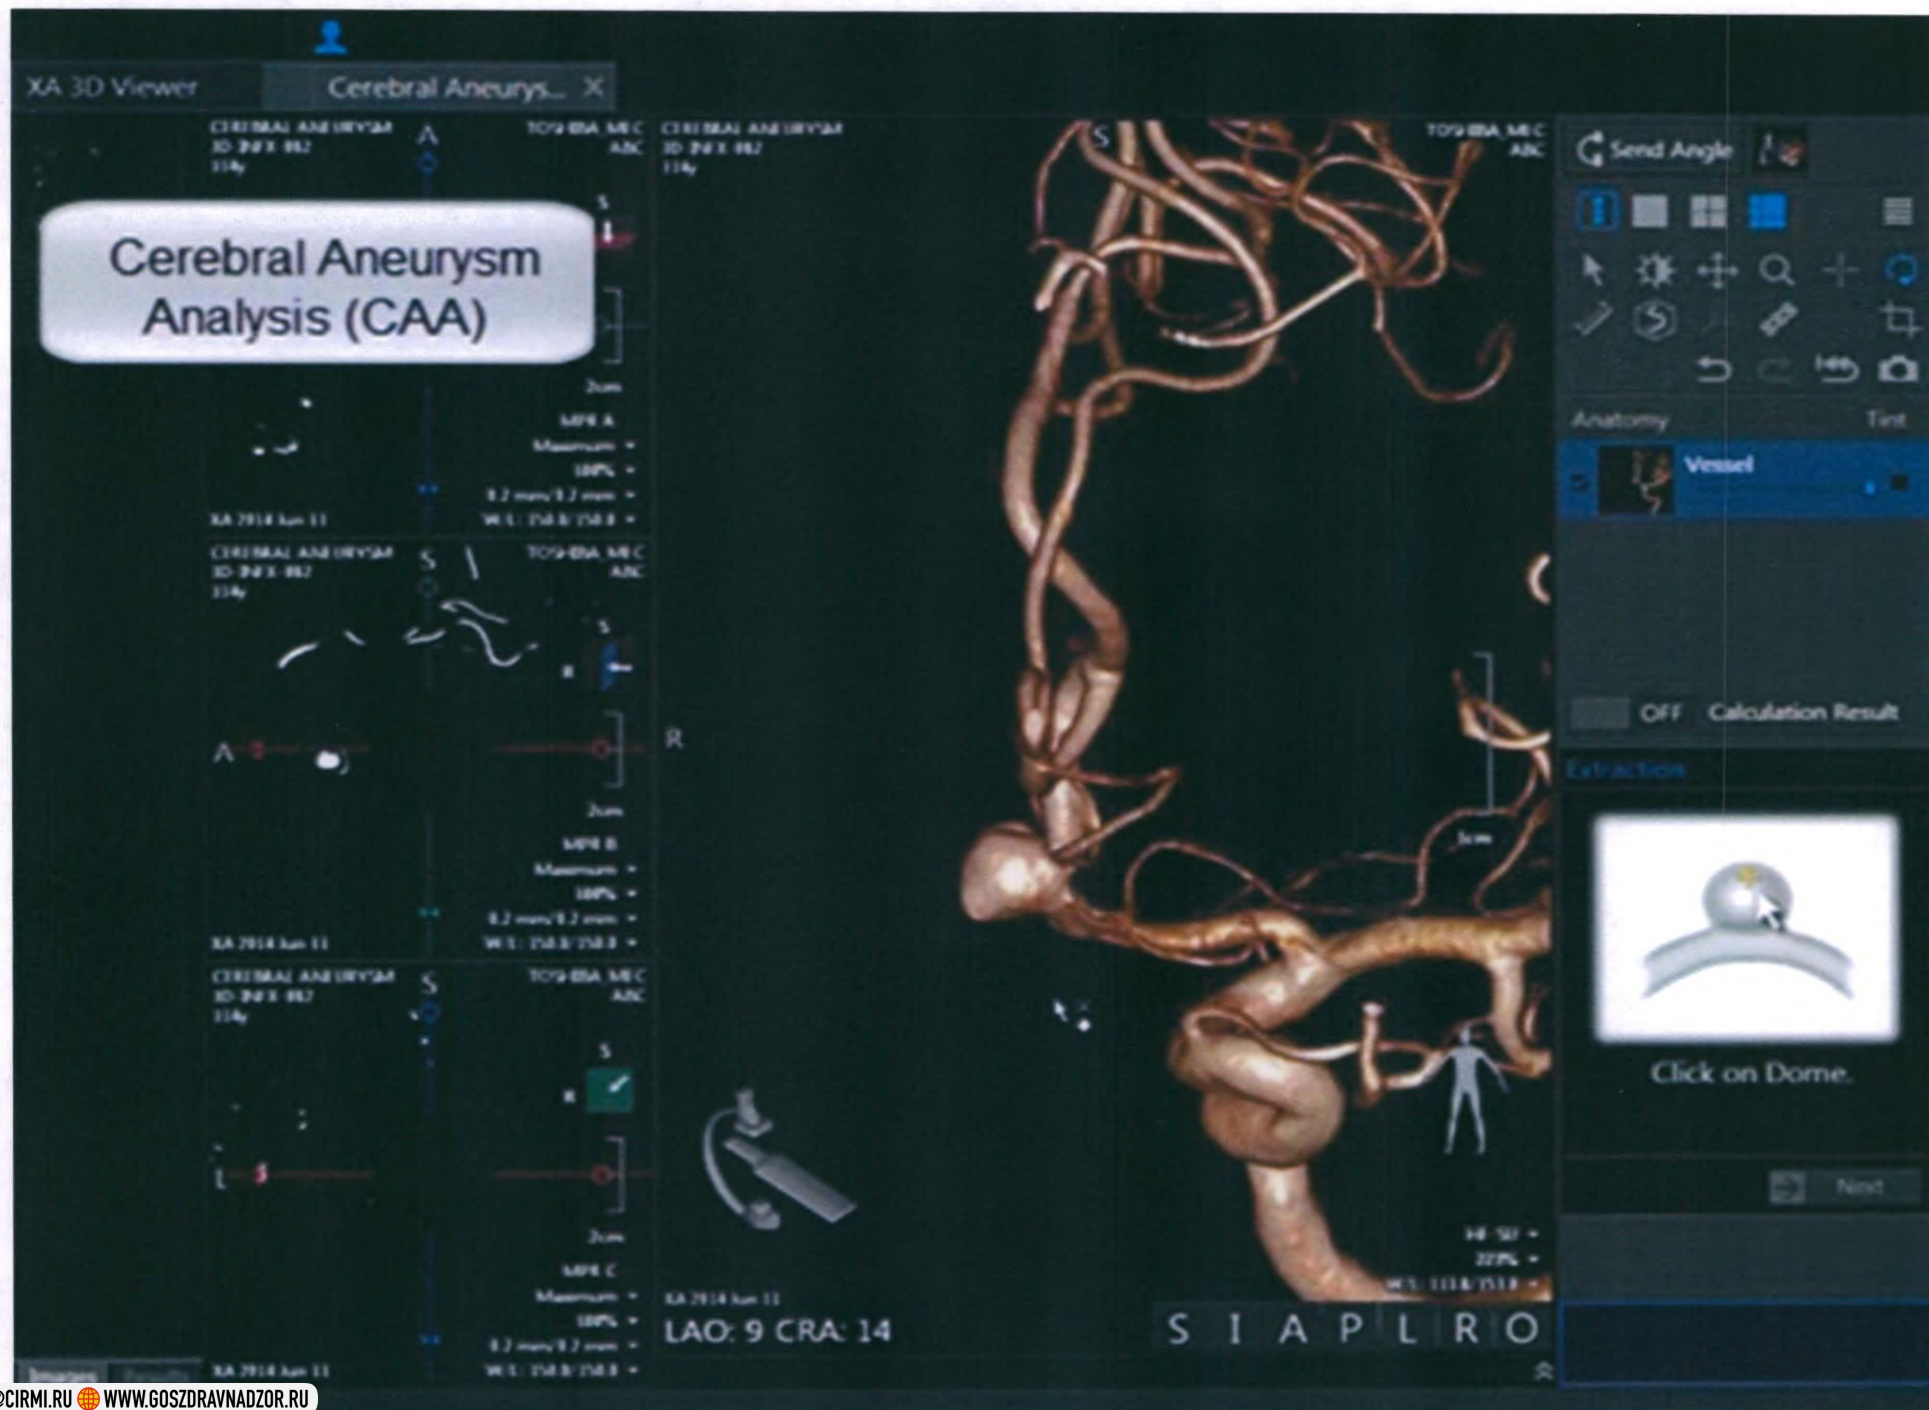


89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет для планирования



89. Программные пакеты для Ангиографической рабочей станции, в вариантах исполнения - не более 25 шт.: - Пакет инструментов 3D-просмотра.




90. Комплект для подключения Rocket Link.

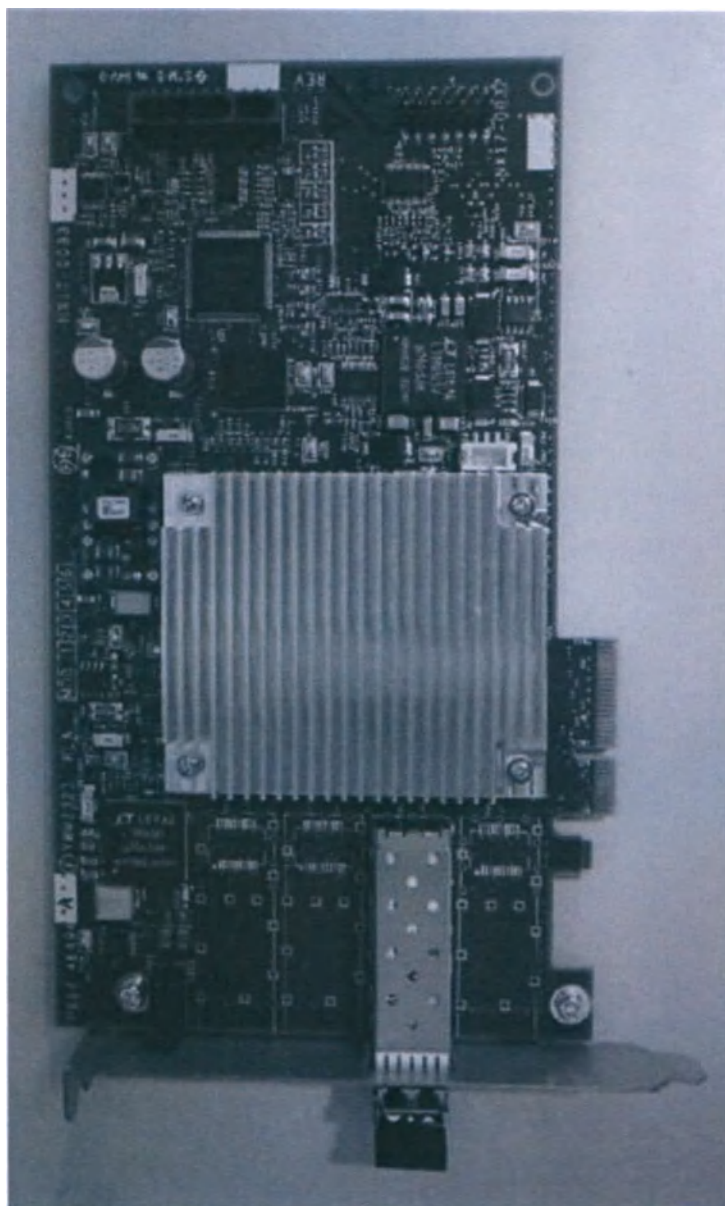




92. Стойка для охладителя.



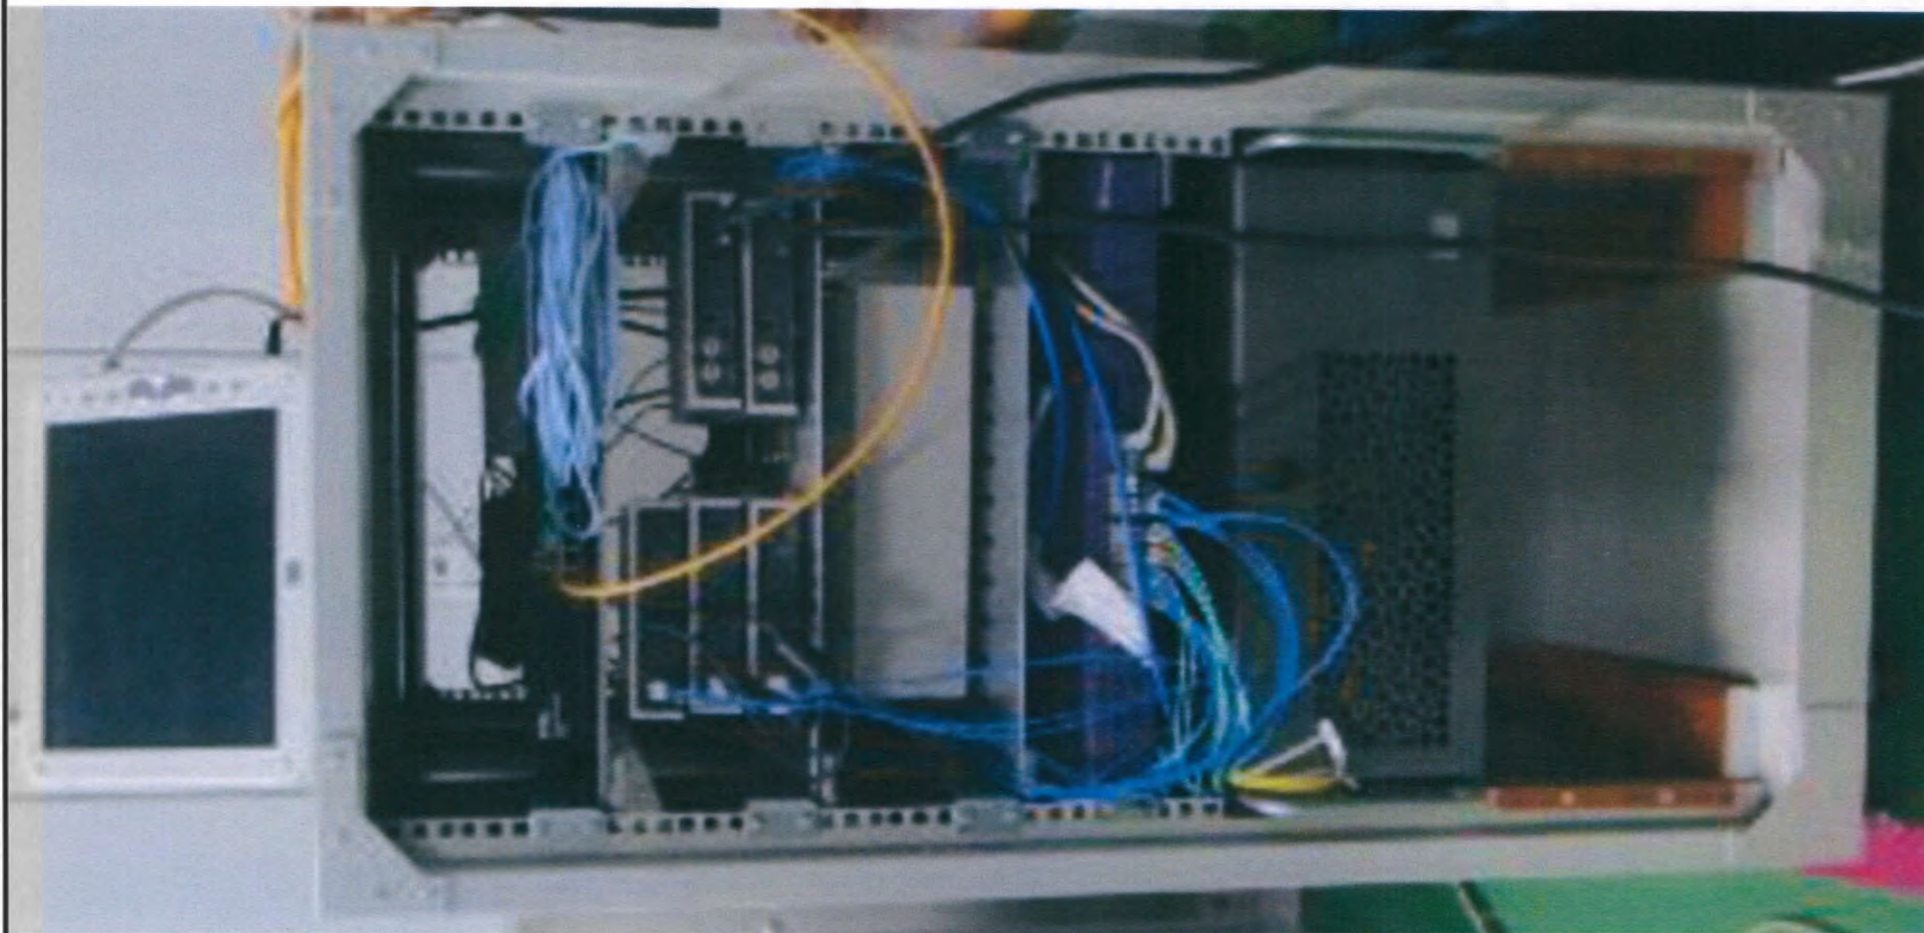



94. Модуль для подключения ИБП.

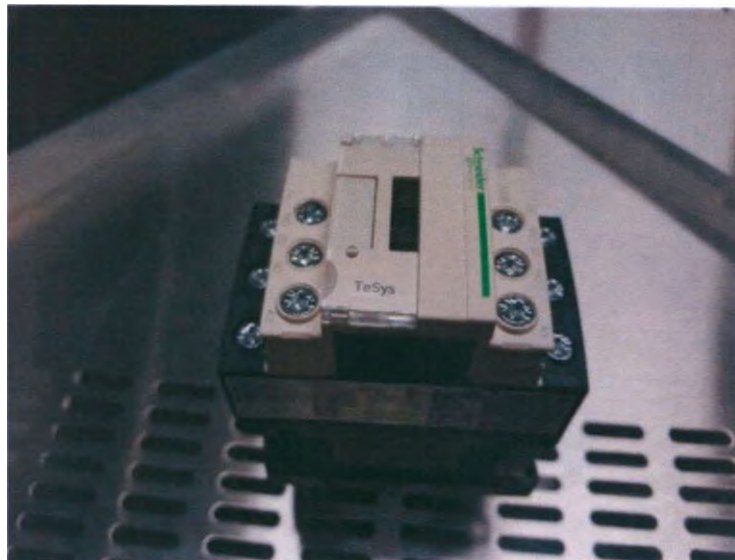

Контактор




Пневматический таймер

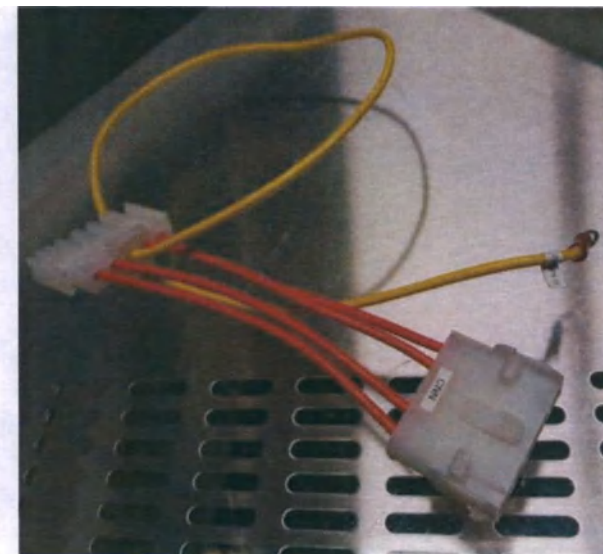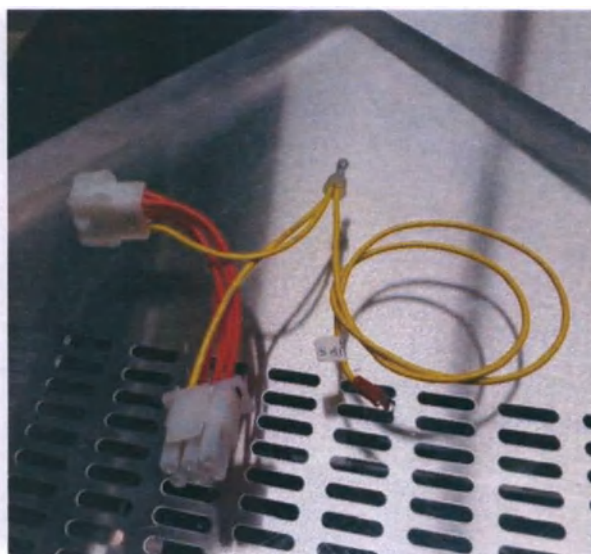

Соединительные кабели





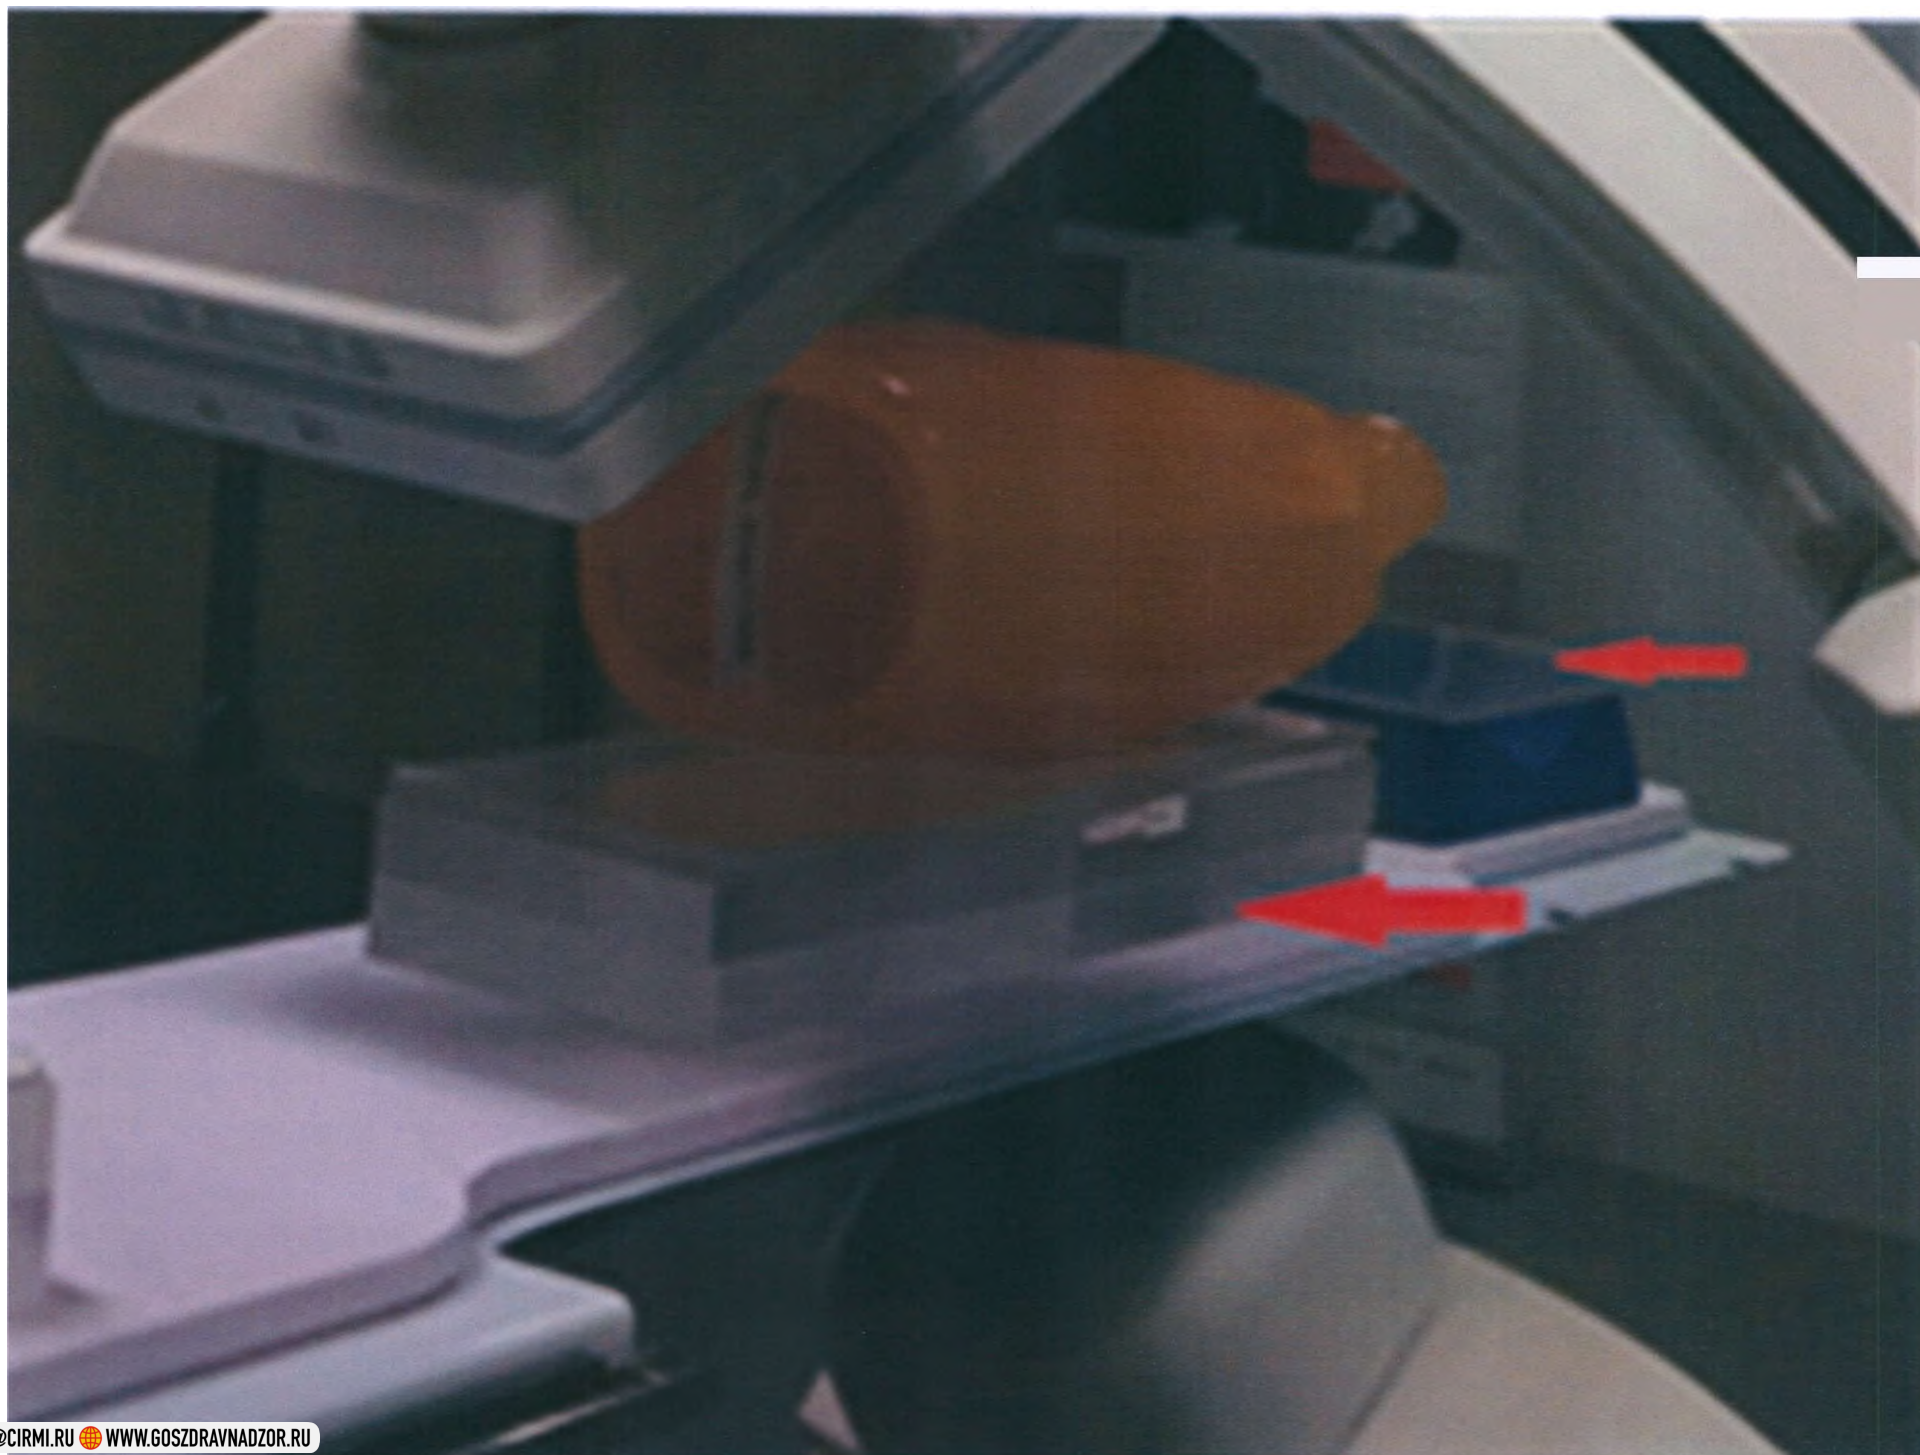



CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

**1385 SHIMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI, 324-8550,
JAPAN**

**Система интервенционная ангиографическая Alphenix
модели INFx-8000V/Y с принадлежностями, варианты
исполнения**

**Уполномоченный представитель производителя в России:
119421, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Обручевский, Ленинский проспект, д. 111, корп. 1, этаж 5,
комната 129**

Сделано в Японии














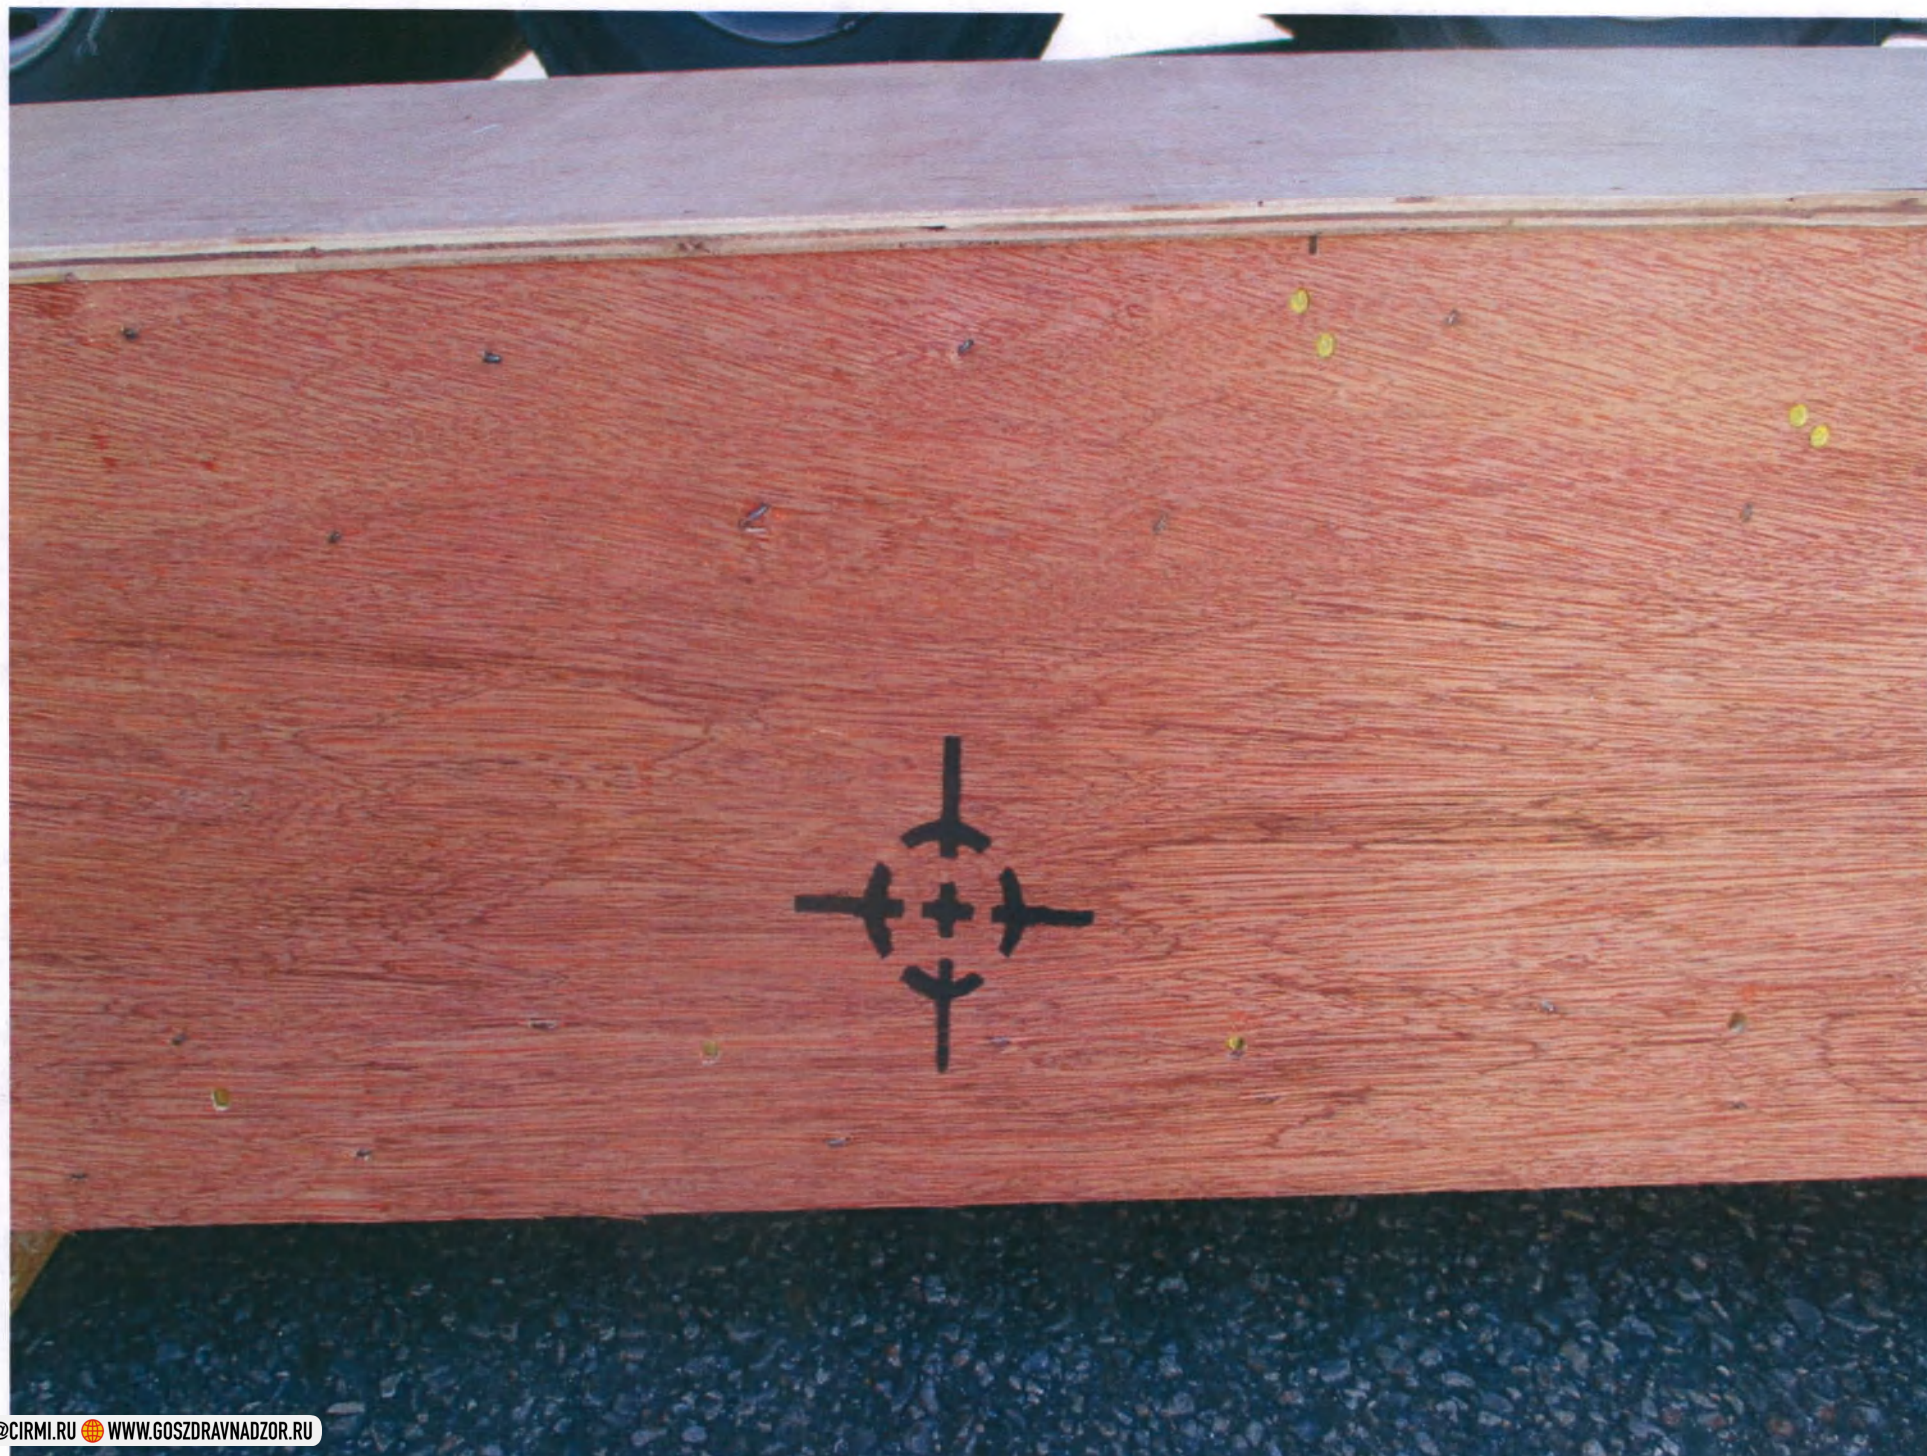

Canon

NQ 16171

G.W.

KG

N.W.

KG

X

X

CM

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 73 листов
Подпись _____

