

Фотографические изображения медицинского изделия

Калибратор для автоматизированной микробиологической системы масс-спектрометрического анализа MALDI-TOF Autof ms1000 для in vitro диагностики

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента регистрации

ООО «ИЛС»



Стариковская И.А.

Калибратор для автоматизированной
микробиологической системы масс-
спектрометрического анализа MALDI-TOF Autof
ms1000 для in vitro диагностики, в составе:

1. Калибратор – 4 флакона.
2. Инструкция по применению – 1 шт.

 «Аутобио Диагностикас Ко., Лтд.» (Autobio
Diagnostics Co., Ltd.) No. 87 Jingbei Yi Road, National
Eco & Tech Development Area, 450016 Zhengzhou,
China


№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Уполномоченный представитель (дистрибьютор) в
РФ: ООО «ИЛС»

115035, Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2


REF MSA02 **LOT** 2022061104  11.06.2023

Только для профессионального применения.



80

Калибратор для автоматизированной микробиологической системы масс-спектрометрического анализа MALDI-TOF Autof ms1000 для in vitro диагностики (общий вид)

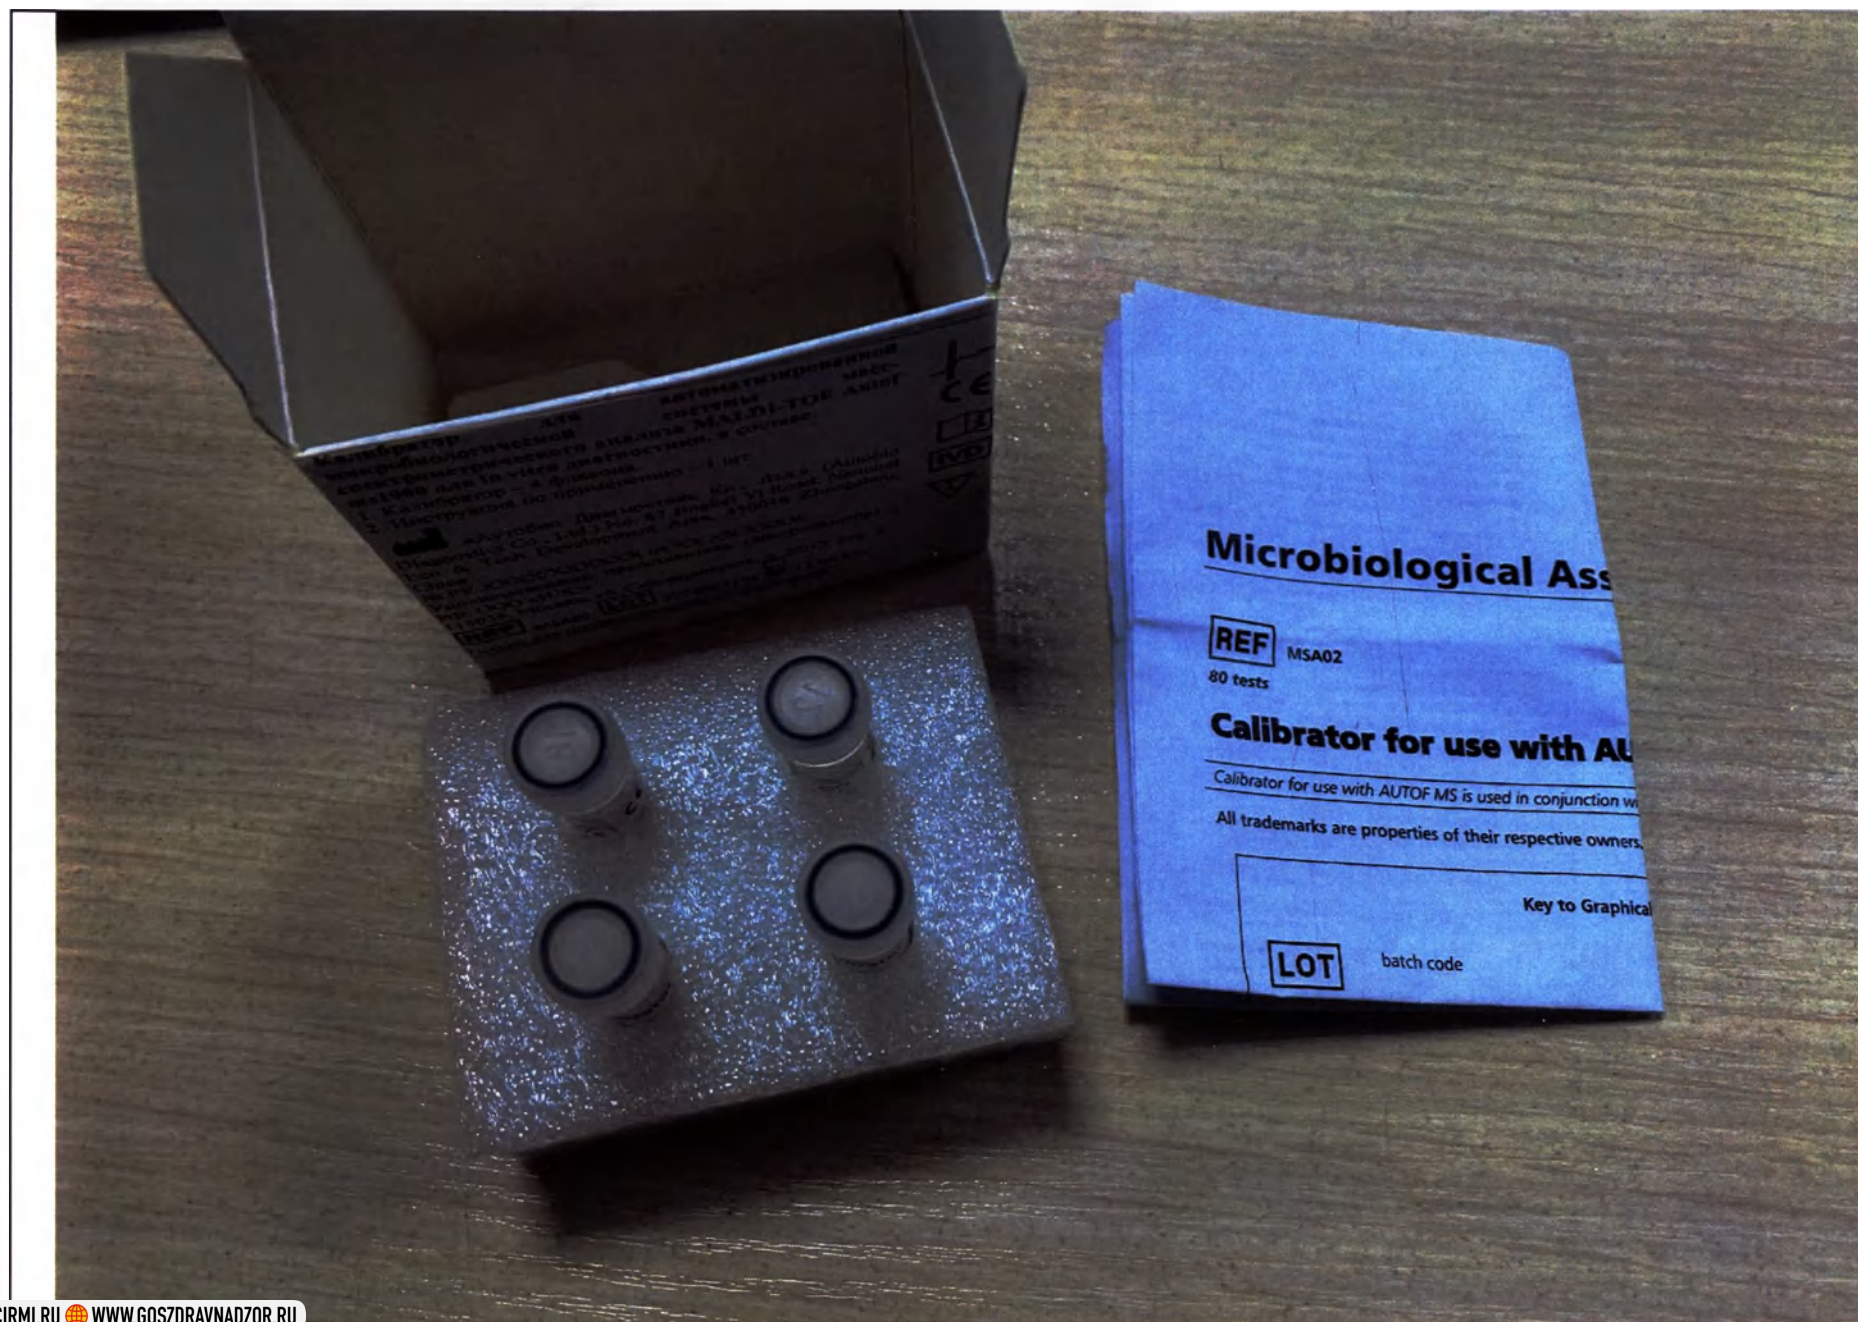

Калибратор для автоматизированной микробиологической системы масс-спектрометрического анализа MALDI-TOF Autof ms1000 для in vitro диагностики (Калибратор – 4 флакона)




Калибратор для автоматизированной микробиологической системы масс-спектрометрического анализа MALDI-TOF Autof ms1000 для in vitro диагностики (Инструкция по применению – 1 шт.)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Калибратор для автоматизированной микробиологической системы масс-спектрометрического анализа MALDI-TOF Autof ms1000 для in vitro диагностики

пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 5 лист (а/ов)
Руководитель департамента регистрации
ООО «ИЛС»




И. А. Стариковская