



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers), в вариантах исполнения

ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва
ул. Летниковская, дом 2, стр. 3
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Факс: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

Roche Diagnostics Rus LLC


2, Letnikovskaya street, bld.3
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 99
Fax: +7 (495) 229 62 64


www.roche.ru

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO II), 100 тестов

Общий вид

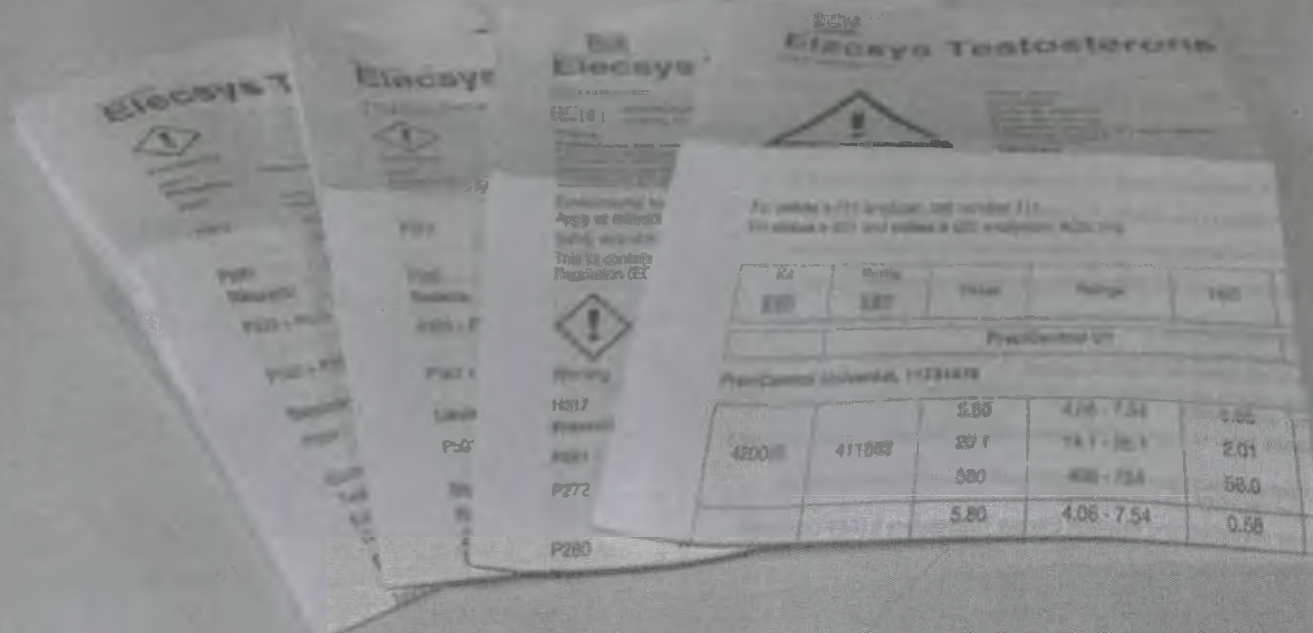

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO II), 100 тестов

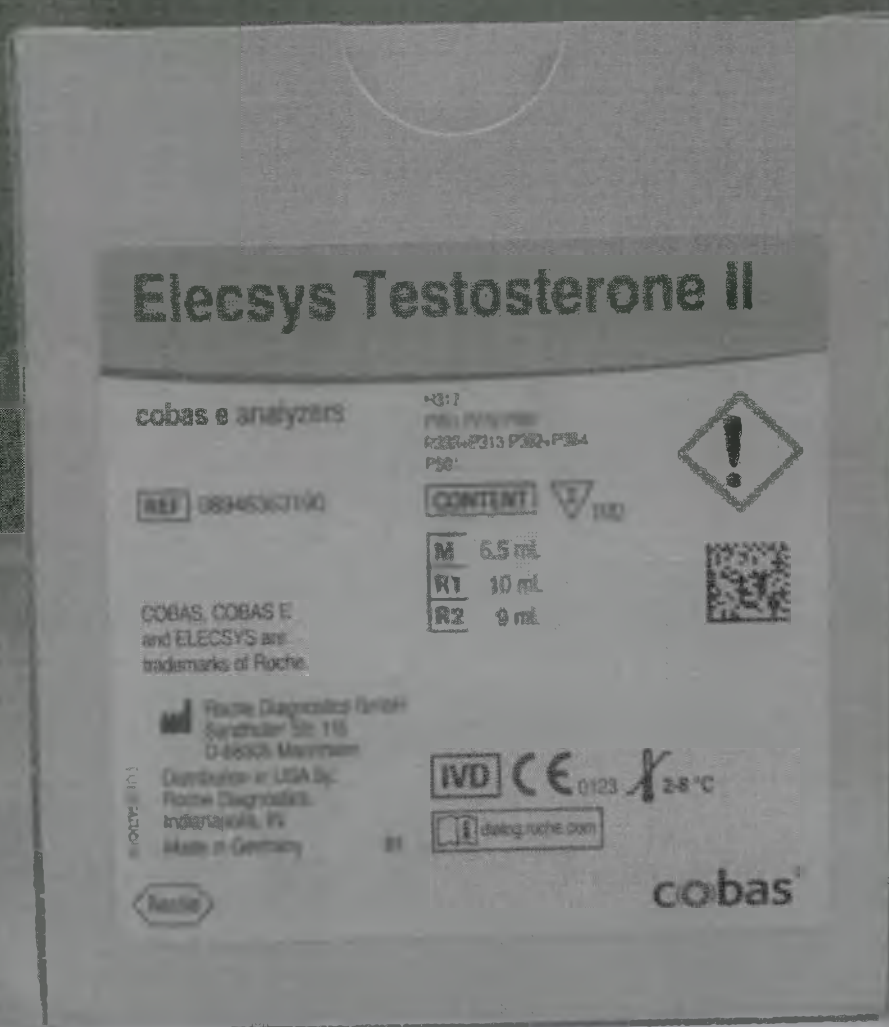

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO II), 100 тестов



Реагенты в картотеке для количественного определения тестостерона иммунохимическими методами. МЕТС.ДОМ
 Сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecys Testos-
 II cobas e analysers/TESTO II), 100 тестов

Elecsys Testosterone II

REF 08946383190

For USA: **CONTENT**

- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/ml
- R1 Biotinylated monoclonal anti-testosterone antibody
(sheep) 40 mg/ml; releasing reagent
2 bromoestradiol
- R2 Testosterone derivative, labelled with ruthenium
complex 1.5 ng/ml



Rx only

01



Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохимическим методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических систем (Eitest Testosterone II cobas e analyzers/TESTO II), 100 тестов

Макет маркировки на русском языке

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохимическим методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических систем (Eitest Testosterone II cobas e analyzers/TESTO II), 100 тестов

Регистрационное удостоверение № PZN 2015/138 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер партии см. на упаковке

Производитель: Roche Diagnostics GmbH ("Рох Дианостикс ГмбХ"), Grenacher

Strasse 115, 68305 Mannheim, Германия

Издание предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Рох Дианостикс Рус» (ООО

Дианостикс Рус), 107021, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495


Факс: +7 495 329-60-64 E-mail: marketing@roche-diagnostic.ru

Кат. номер 08948352190

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO II), 100 тестов

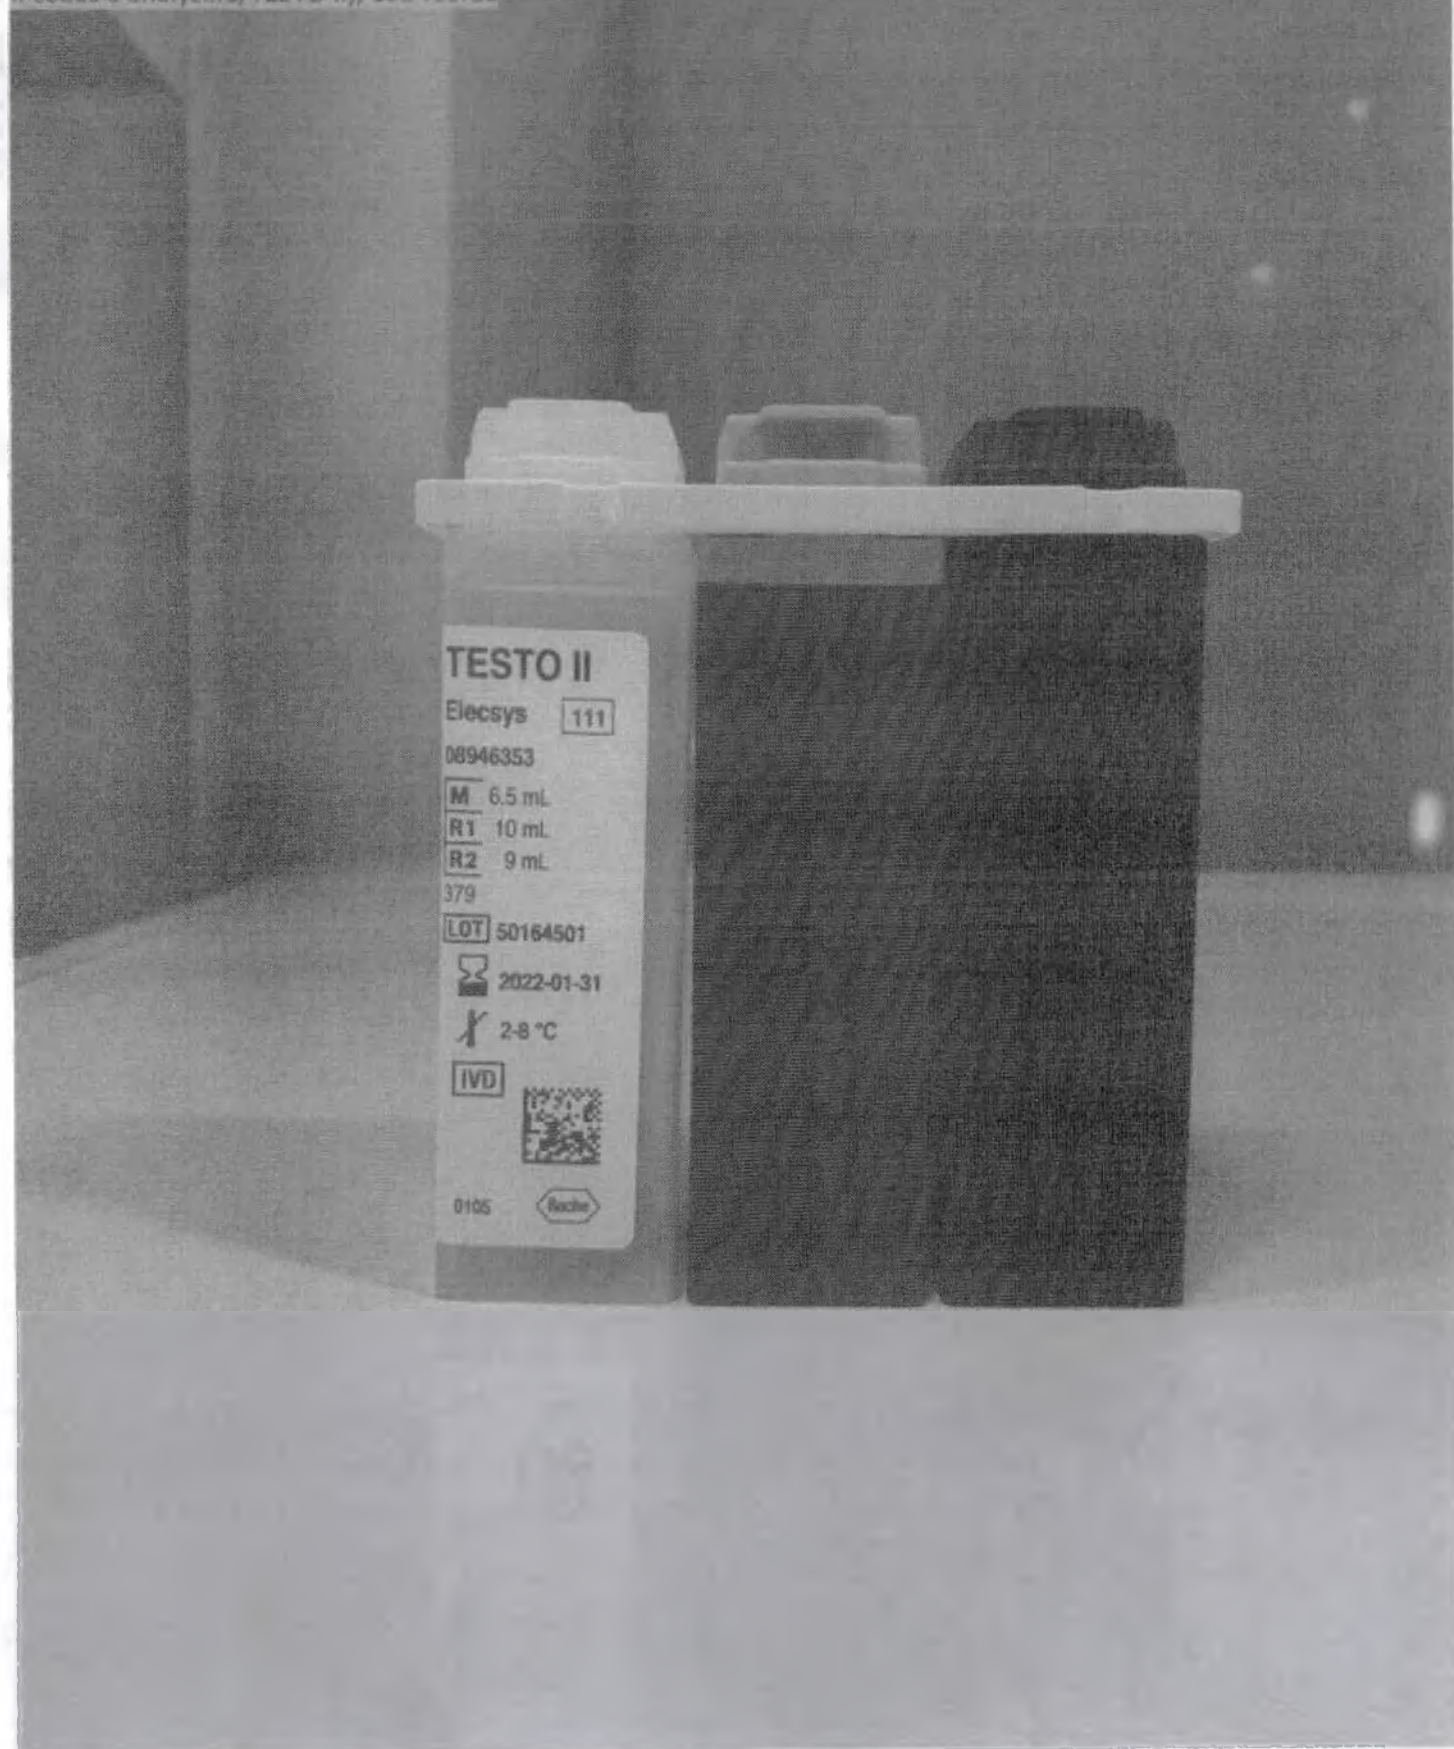


Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохимическим методом в
сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone
II cobas e analyzers/TESTO II), 100 тестов

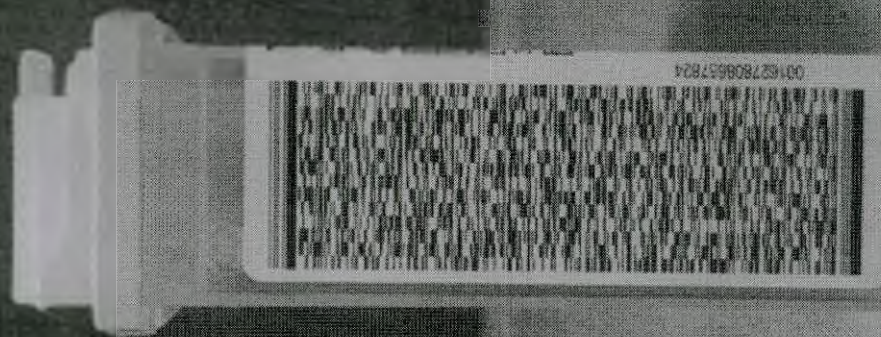

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone cobas e analyzers/TESTO II), 100 тестов





агенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone) cobas e analyzer / TESTO III, 100 тестов

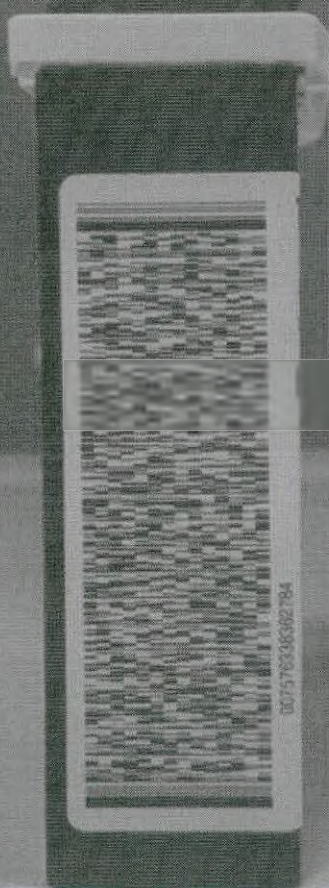

Реагенты в касете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO 2), 300 тестов

Общий вид

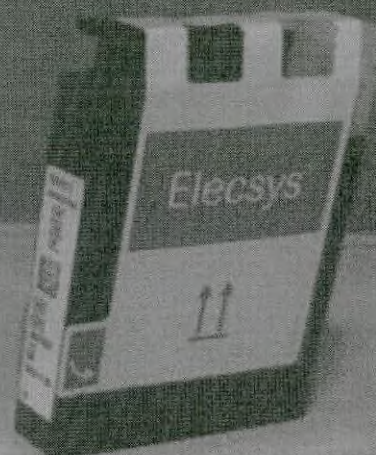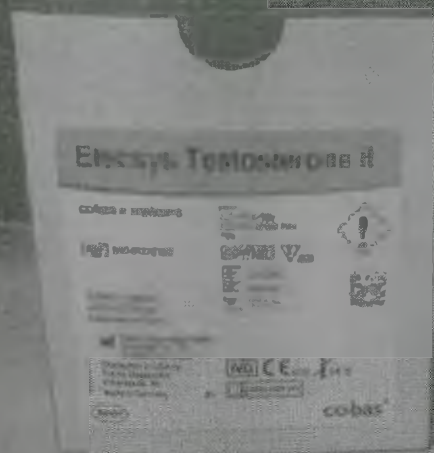

Elecsys Testosterone II

Целевое назначение: Определение тестостерона в сыворотке и плазме крови человека.

Применение: Для диагностики заболеваний, связанных с нарушением функции надпочечников и гипофиза, а также для контроля лечения.

Состав: Реагентная смесь, содержащая антитела к тестостерону.

Безопасность: Реагентная смесь не содержит опасных веществ. Однако, как и все биологические материалы, она может содержать патогенные микроорганизмы. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ней.

Pre USA: Please refer to the package insert for full instructions.

Elecsys

ВНИМАНИЕ! Содержит биологические материалы. Соблюдать меры предосторожности при обращении.

CE **ISO 13485**

English

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.



Warning

Elecsys Testosterone II

Целевое назначение: Определение тестостерона в сыворотке и плазме крови человека.

Применение: Для диагностики заболеваний, связанных с нарушением функции надпочечников и гипофиза, а также для контроля лечения.

Состав: Реагентная смесь, содержащая антитела к тестостерону.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

Precautions and Warnings: For in vitro diagnostic use only. Handle according to the Environmental Safety data. For USA: Call a physician. This kit is a Regulator.

colas e analisadores IMPACT PLUS INC.CONTENTS

COSAR, COSAS E
 O QUE É O COSAR E
 O QUE É O COSAS E

R1	21.0 ml
R2	18.8 ml
R3	12.4 ml

Home Diagnostic Center
 800-828-1178
 www.hdc-usa.com


Reine Diagnostik.
Indiansch, IN
Made in Germany

 Elsevier.com

Reiche

cobas®

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO 2), 300 тестов

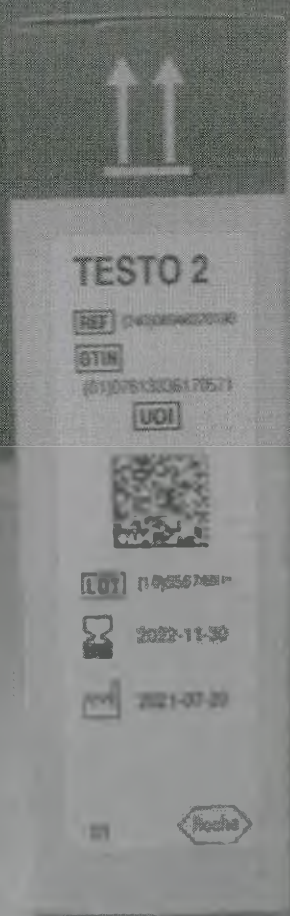

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO 2), 300 тестов

Elecsys Testosterone II

(KIT) 08946372100

For USA (USA)

- Steroid-coated microplates 5.72 ng/mL
- R1 Biotinylated monoclonal anti-testosterone antibody (sheep) 40 ng/mL, releasing reagent 2-bromoestradiol
- R2 Testosterone derivative, labeled with ruthenium complex 1.5 ng/mL



file.ang

21



Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO 2), 300 тестов

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO 2), 300 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/0136 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» («Роиш Диагностика ГмбХ», Sandhofer
Strasse 118, 68305 Mannheim, Germany, Германия)

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Роиш Диагностика Руса ЮОО»


«Роиш Диагностика Руса», 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495

229-60-00

факс: +7 495 229-62-64. E-mail: roschka.registration_gis@roche.com

Кат. номер 08948370190

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO 2), 300 тестов

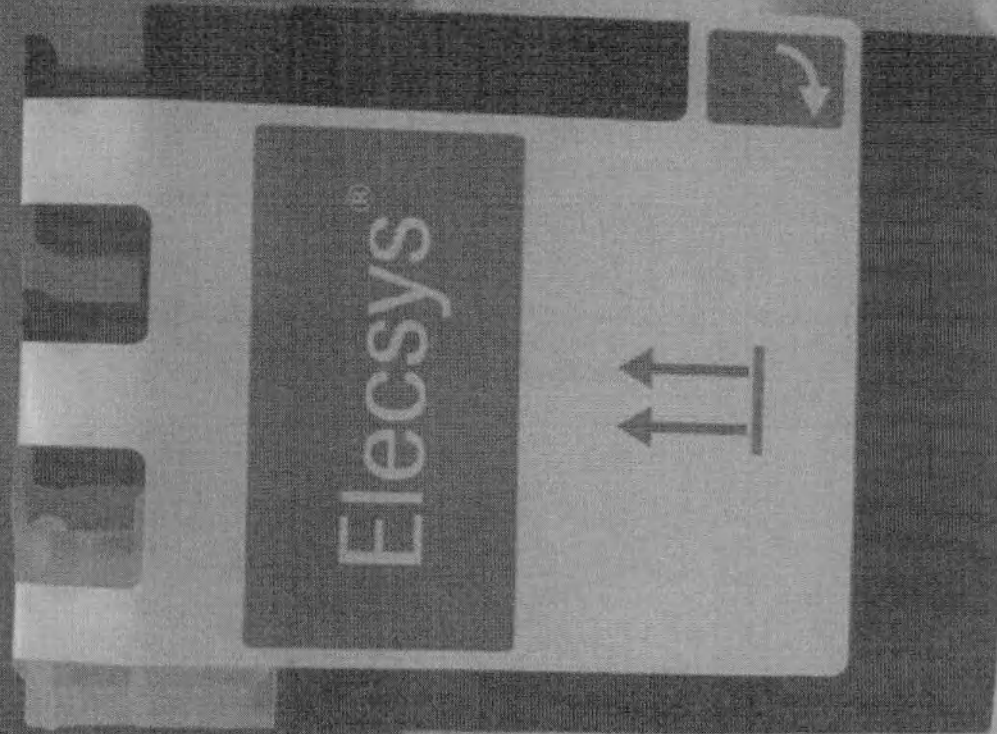

Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для модулей иммунохимических cobas e (Elicsys Testosterone II cobas e analyzers; TESTO 2), 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Testosterone II cobas e analyzers/TESTO 2), 300 тестов



Всего пронумеровано.
прошнуровано и
скреплено печатью
18 листа (ов)



М.И. Мафганисов
11.08.2011.