

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова
2022 г.

Образцы маркировки

Набор реагентов для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* «Toxoplasma IgG Авидность-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-165-41390295-2022

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Toxoplasma IgG Авидность-ИМБИАН-ИФА»

Наименование компонента	Этикетка
Иммуносорбент	
Инактивированный положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG антитела $K_{BA}(+)$	
Инактивированный положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG антитела $K_{HA}(+)$	
Инактивированный отрицательный контрольный образец $K(-)$	

Стоп-реагент

Тохорасма IgG Авидность-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 20,0 мл

LOT XXXXXX

ГТГ-ММ-ДД



2. Образцы этикеток на шоу-боксе набора «Трихомониаз IgG-ИМБИАН-ИФА»

2.1. Образец основной этикетки

Тохорасма IgG
Авидность-
ИМБИАН-ИФА

набор реагентов для определения индекса авидности
иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii*
«Тохорасма IgG Авидность-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-165-41390295-2022

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- | | |
|---|--------|
| 1 Иммуносорбент | 1 шт. |
| 2 K ₊ (+) - инактивированный положительный контрольный образец, содержащий высокавидные антитела IgG к <i>Toxoplasma gondii</i> (2,0 мл) | 1 фл. |
| 3 K ₋ (-) - инактивированный отрицательный контрольный образец, содержащий низкоавидные антитела IgG к <i>Toxoplasma gondii</i> (2,0 мл) | 1 фл. |
| 4 K(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл) | 1 фл. |
| 5 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (50,0 мл) | 1 фл. |
| 6 РРО - раствор для разведения образцов (20,0 мл) | 1 фл. |
| 7 РК - раствор конъюгата (13,0 мл) | 1 фл. |
| 8 РС - раствор сравнения (7,0 мл) | 1 фл. |
| 9 ДА - раствор диссоциирующего агента (7,0 мл) | 1 фл. |
| 10 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл) | 1 фл. |
| 11 Стоп-реагент (20,0 мл) | 1 фл. |
| 12 Пленка для заклеивания планшета | 4 шт. |
| 13 Ванночки для реагентов | 24 шт. |
| 14 Наконечники для пипеток | 1 шт. |
| 15 Инструкция по применению набора реагентов | |

Для профессионального применения
Для клинической лабораторной диагностики
Антитела к ВПЧ-1,2, вирусу гепатита С, HBsAg отсутствуют
3-й набор реагентов не допускается

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF TE-017/48

ГТГ-ММ-ДД

ГТГ-ММ-ДД

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

2.2. Образец боковой этикетки



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2



Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Imbian




8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp:
+73832093454

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
лист 2
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипов
2022 г

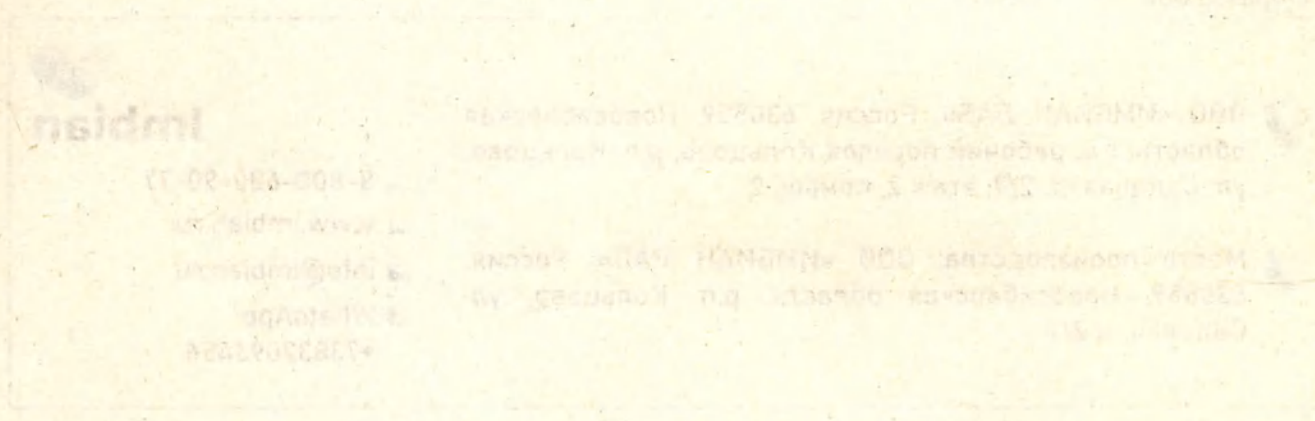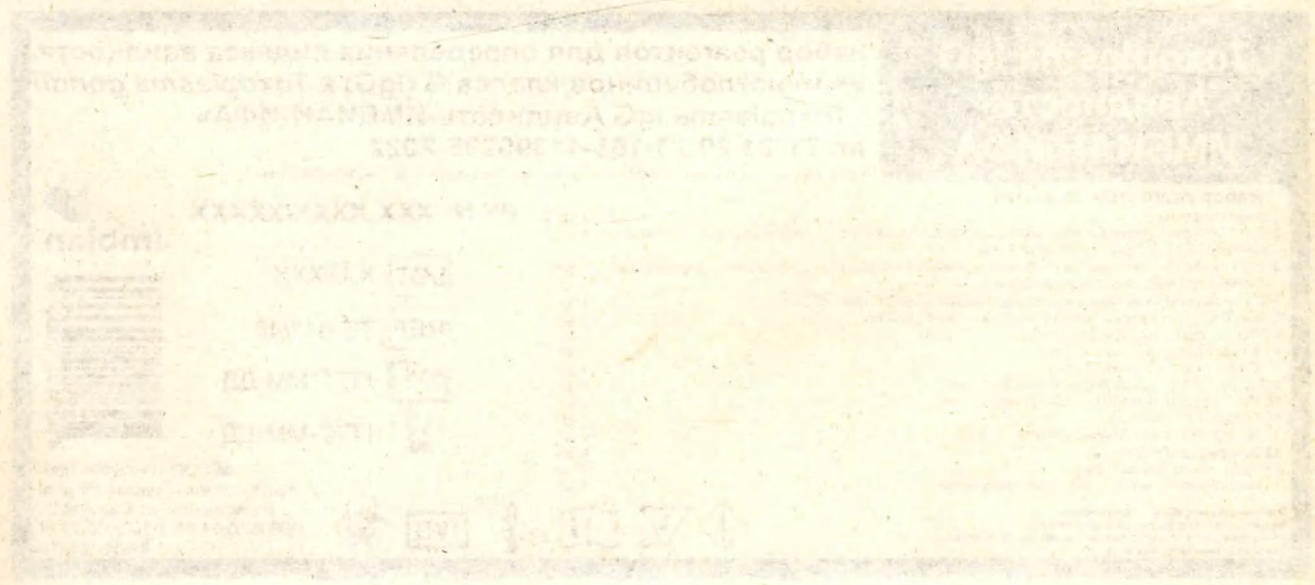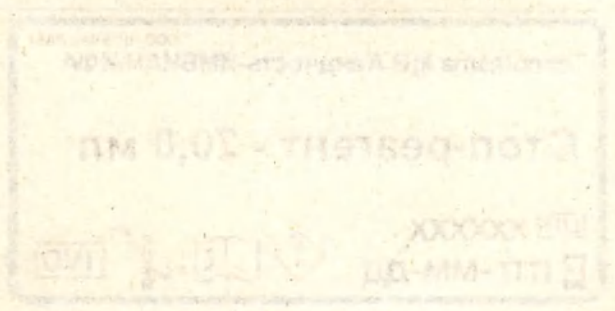

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова



2022 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики in vitro

**Набор реагентов для определения индекса авидности иммуноглобулинов
класса G (IgG) к Toxoplasma gondii «Toxoplasma IgG Авидность-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-165-41390295-2022**



Тохорlasma IgG Авидность- ИМБИАН-ИФА

набор реагентов для определения индекса авидности
иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii*
«Тохорlasma IgG Авидность-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-165-41390295-2022

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- | | |
|--|--------|
| 1 Иммуносорбент | 1 шт. |
| 2 K ₁ (+) - инактивированный положительный контрольный образец, содержащий высокоаверные антитела IgG к <i>Toxoplasma gondii</i> (2,0 мл) | 1 фл. |
| 3 K ₂ (+) - инактивированный положительный контрольный образец, содержащий низкоаверные антитела IgG к <i>Toxoplasma gondii</i> (2,0 мл) | 1 фл. |
| 4 K(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл) | 1 фл. |
| 5 ФСБ-Т(x26) - концентрат промывочного раствора (50,0 мл) | 1 фл. |
| 6 РРО - раствор для разведения образца (20,0 мл) | 1 фл. |
| 7 РК - раствор конъюгата (13,0 мл) | 1 фл. |
| 8 РС - раствор сравнения (7,0 мл) | 1 фл. |
| 9 ДА - раствор диссоциирующего агента (7,0 мл) | 1 фл. |
| 10 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл) | 1 фл. |
| 11 Стоп-реагент (20,0 мл) | 4 шт. |
| 12 Пленка для заклеивания планшетов | 4 шт. |
| 13 Баночки для реагентов | 24 шт. |
| 14 Наконечники для пипеток | 1 шт. |
| 15 Инструкция по применению набора реагентов | |

Для профессионального применения
Для клинической лабораторной диагностики
Антитела к ВРП-1,2, вирусу гепатита С, ИВВ-Ав отечественные
Затрагивание не допускается

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF TE-017/48

ГТТТ-ММ-ДД

ГТТТ-ММ-ДД

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru




Тохорlasma IgG
Авидность-
ИМБИАН-ИФА

Иммуносорбент

96-луночный разборный до лунок
полистироловый планшет для
иммунологических реакций с плоским дном
(12 стрипов по 8 лунок) с сорбированным
рекомбинантным антигеном,
иммунологически идентичным антигену
Toxoplasma gondii

LOT XXXXXX ГТТТ-ММ-ДД

IVD

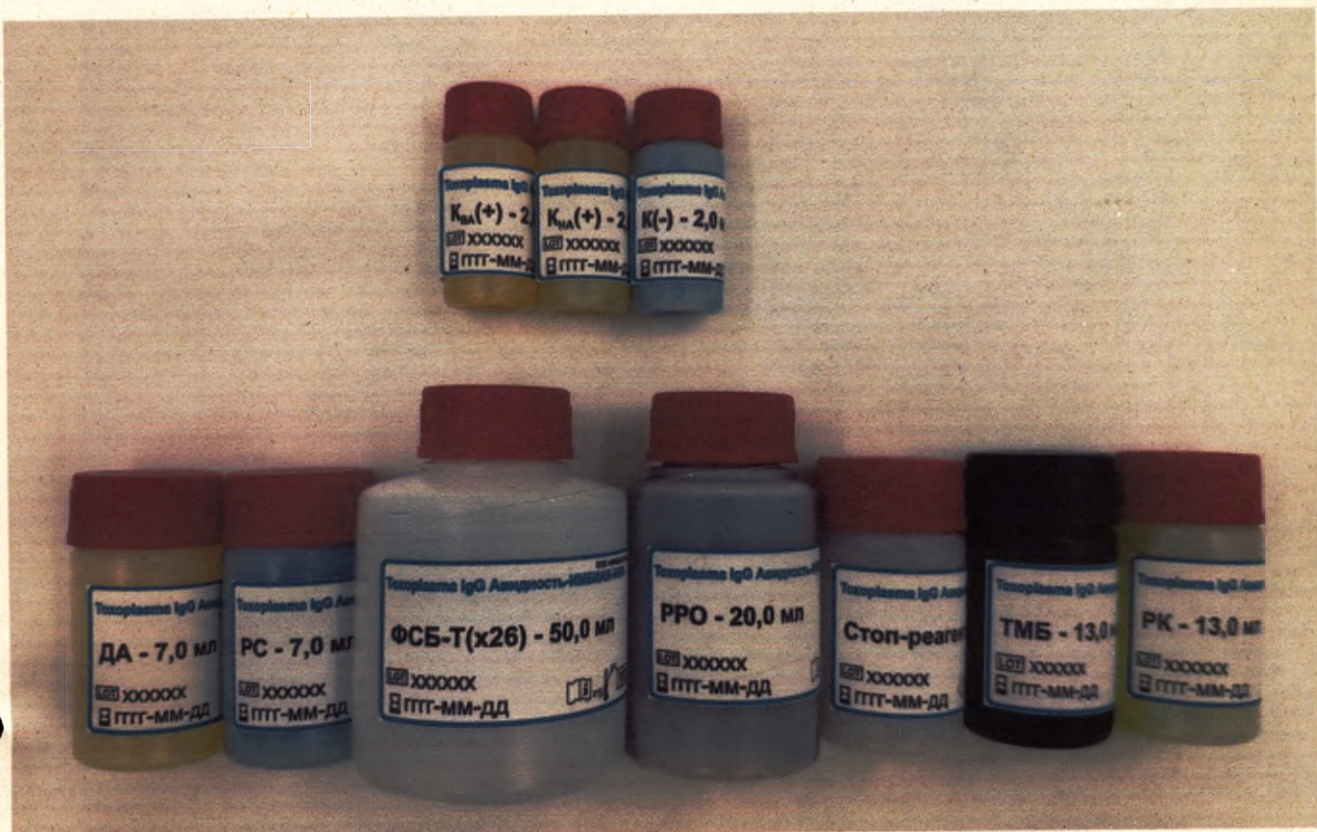

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"16" 10 2022 г.

