

УТВЕРЖДАЮ»

ООО «КОНСУНГ РУС»

Генеральный директор
(должность)
Мерозов А.В.
(имя)

(подпись)
«13» *Сентябрь* 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в образце слюны человека методом иммунохроматографического анализа «COVID-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)»,

Lot № S4021112701

Производитель:

«Цзянсу Аккьюраси Байотехнолоджи Ко., Лтд.»

(Jiangsu Accuracy Biotechnology Co., Ltd.)

№ 8, Западная дорога Шэнчан, Зона развития Даньян, 212300 Даньян провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика

(No. 8, Shengchang West Road, Danyang Development Zone, 212300 Danyang Jiangsu Province, People's Republic of China)

Фото 1. Потребительская упаковка - Набор реагентов для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в образце слюны человека методом иммунохроматографического анализа «COVID-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)», Lot № S4021112701 (Вариант комплектации 1)



7



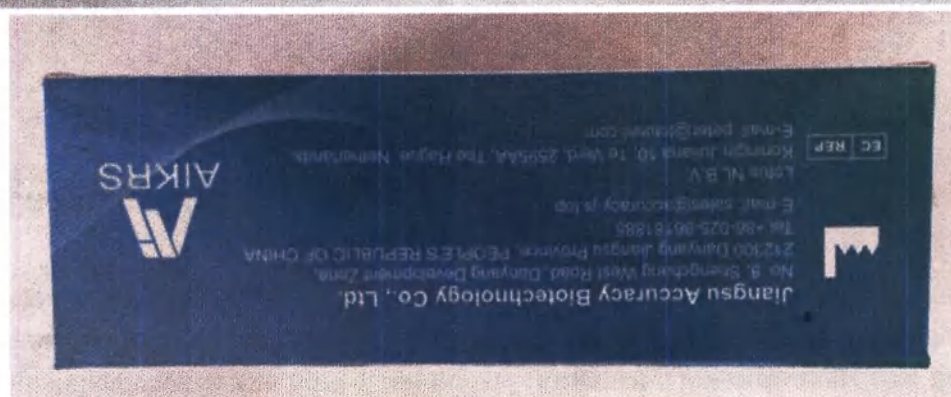


Фото 2. Общий вид медицинского изделия: Набор реагентов для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в образце слюны человека методом иммунохроматографического анализа «COVID-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)», Lot № S4021112701 (Вариант комплектации 1)

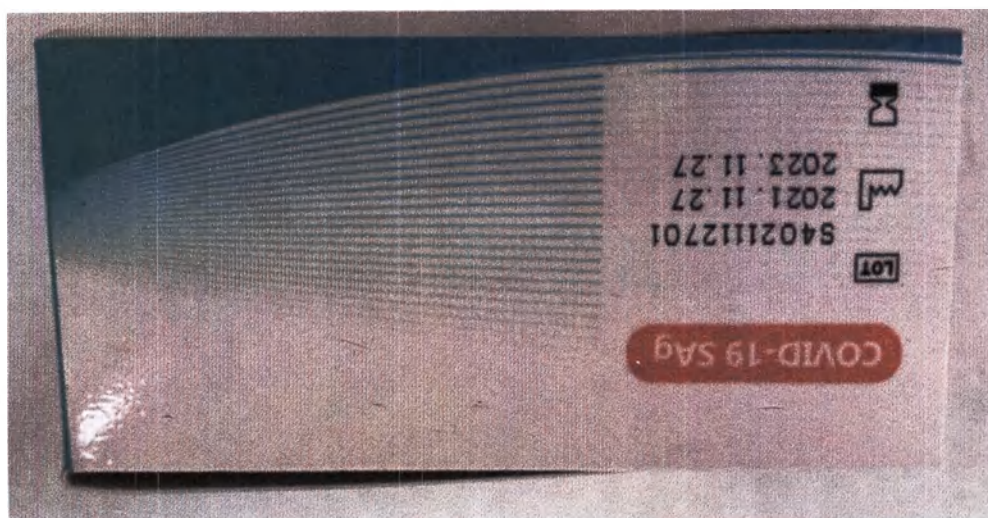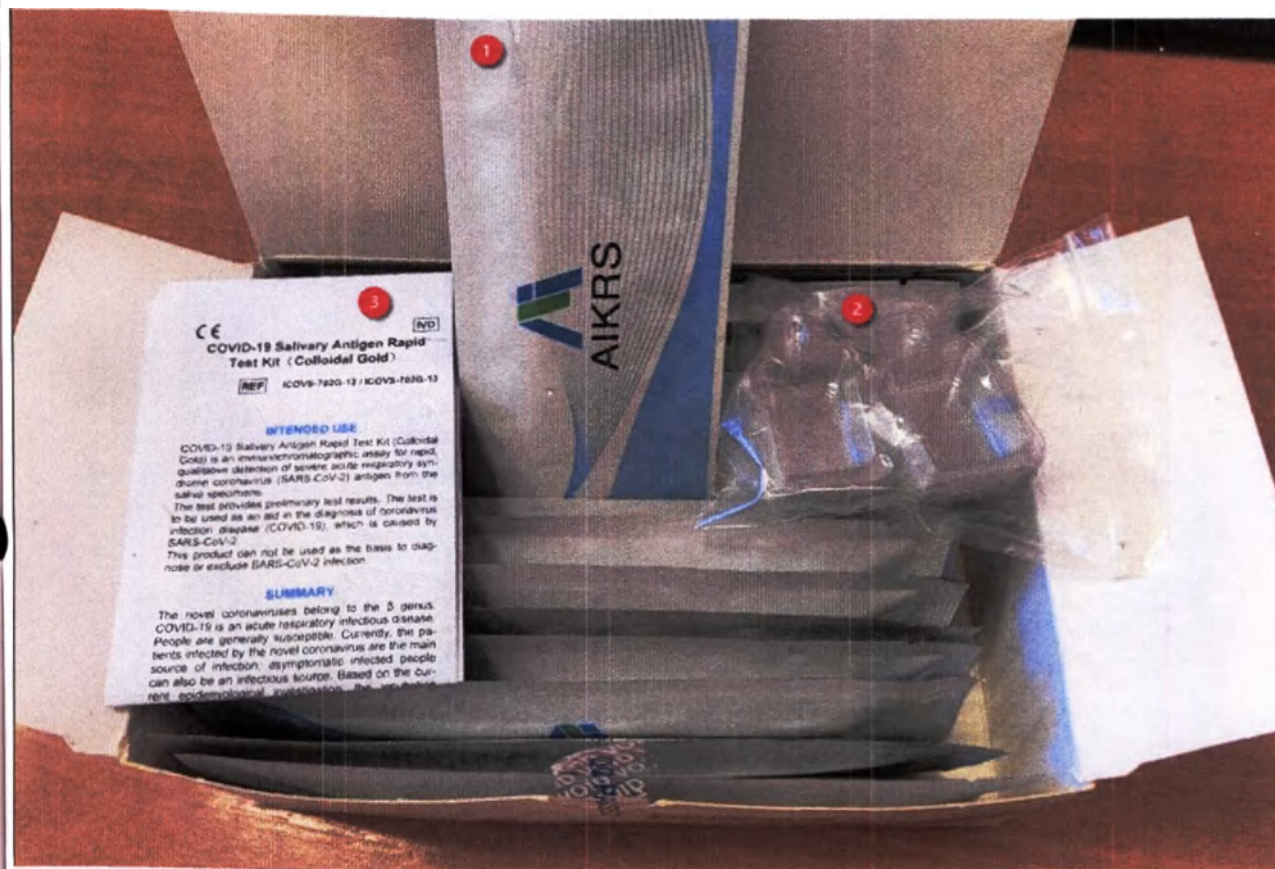

1. Тестовая кассета COVID-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем – 20 шт.
2. Одноразовый стаканчик – 20 шт.
3. Инструкция по применению – 1 экз.

Фото 3. Потребительская упаковка: Набор реагентов для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в образце слюны человека методом иммунохроматографического анализа «COVID-19 Salivary

Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)», Lot № S4021112701
(Вариант комплектации 2)




Фото 4. Общий вид медицинского изделия: Набор реагентов для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в образце слюны человека методом иммунохроматографического анализа «COVID-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)», Lot № S4021112701. (Вариант комплектации 2)



Фото 5. Общий вид: Тестовой кассеты COVID-19 Salivary Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем



Фото 6. Общий вид: Одноразовый стаканчик

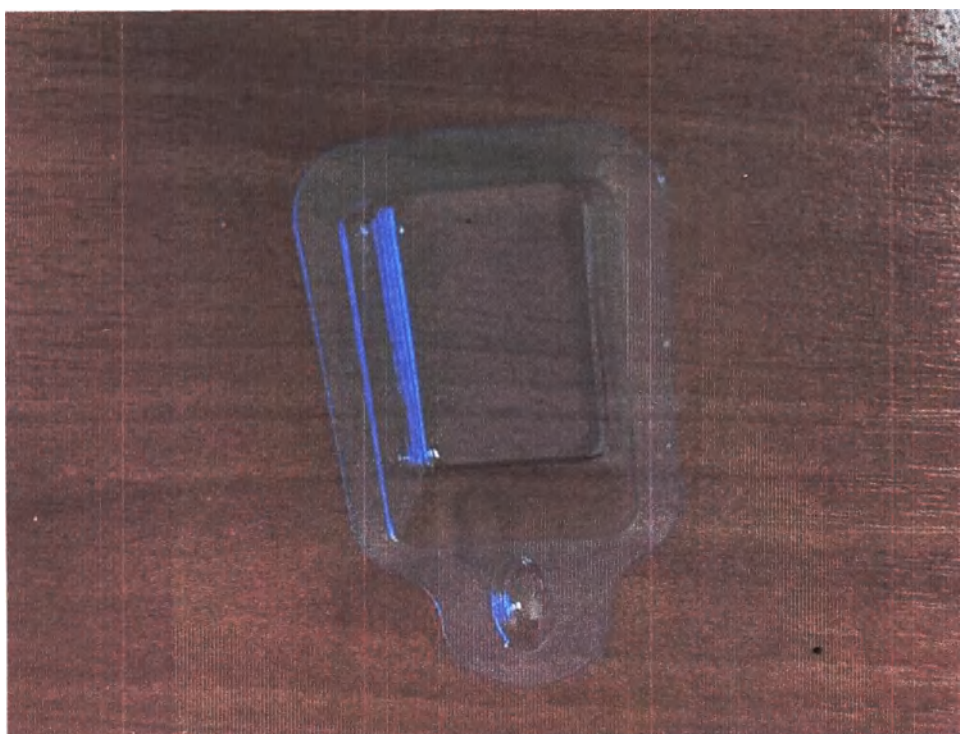

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на

8

листах

Морозов А. В.
ген. директор

