

PHILIPS

Руководитель по нормативному
регулированию ООО "ФИЛИПС"




Горкуша Д.В.


«06» августа 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


«Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями»

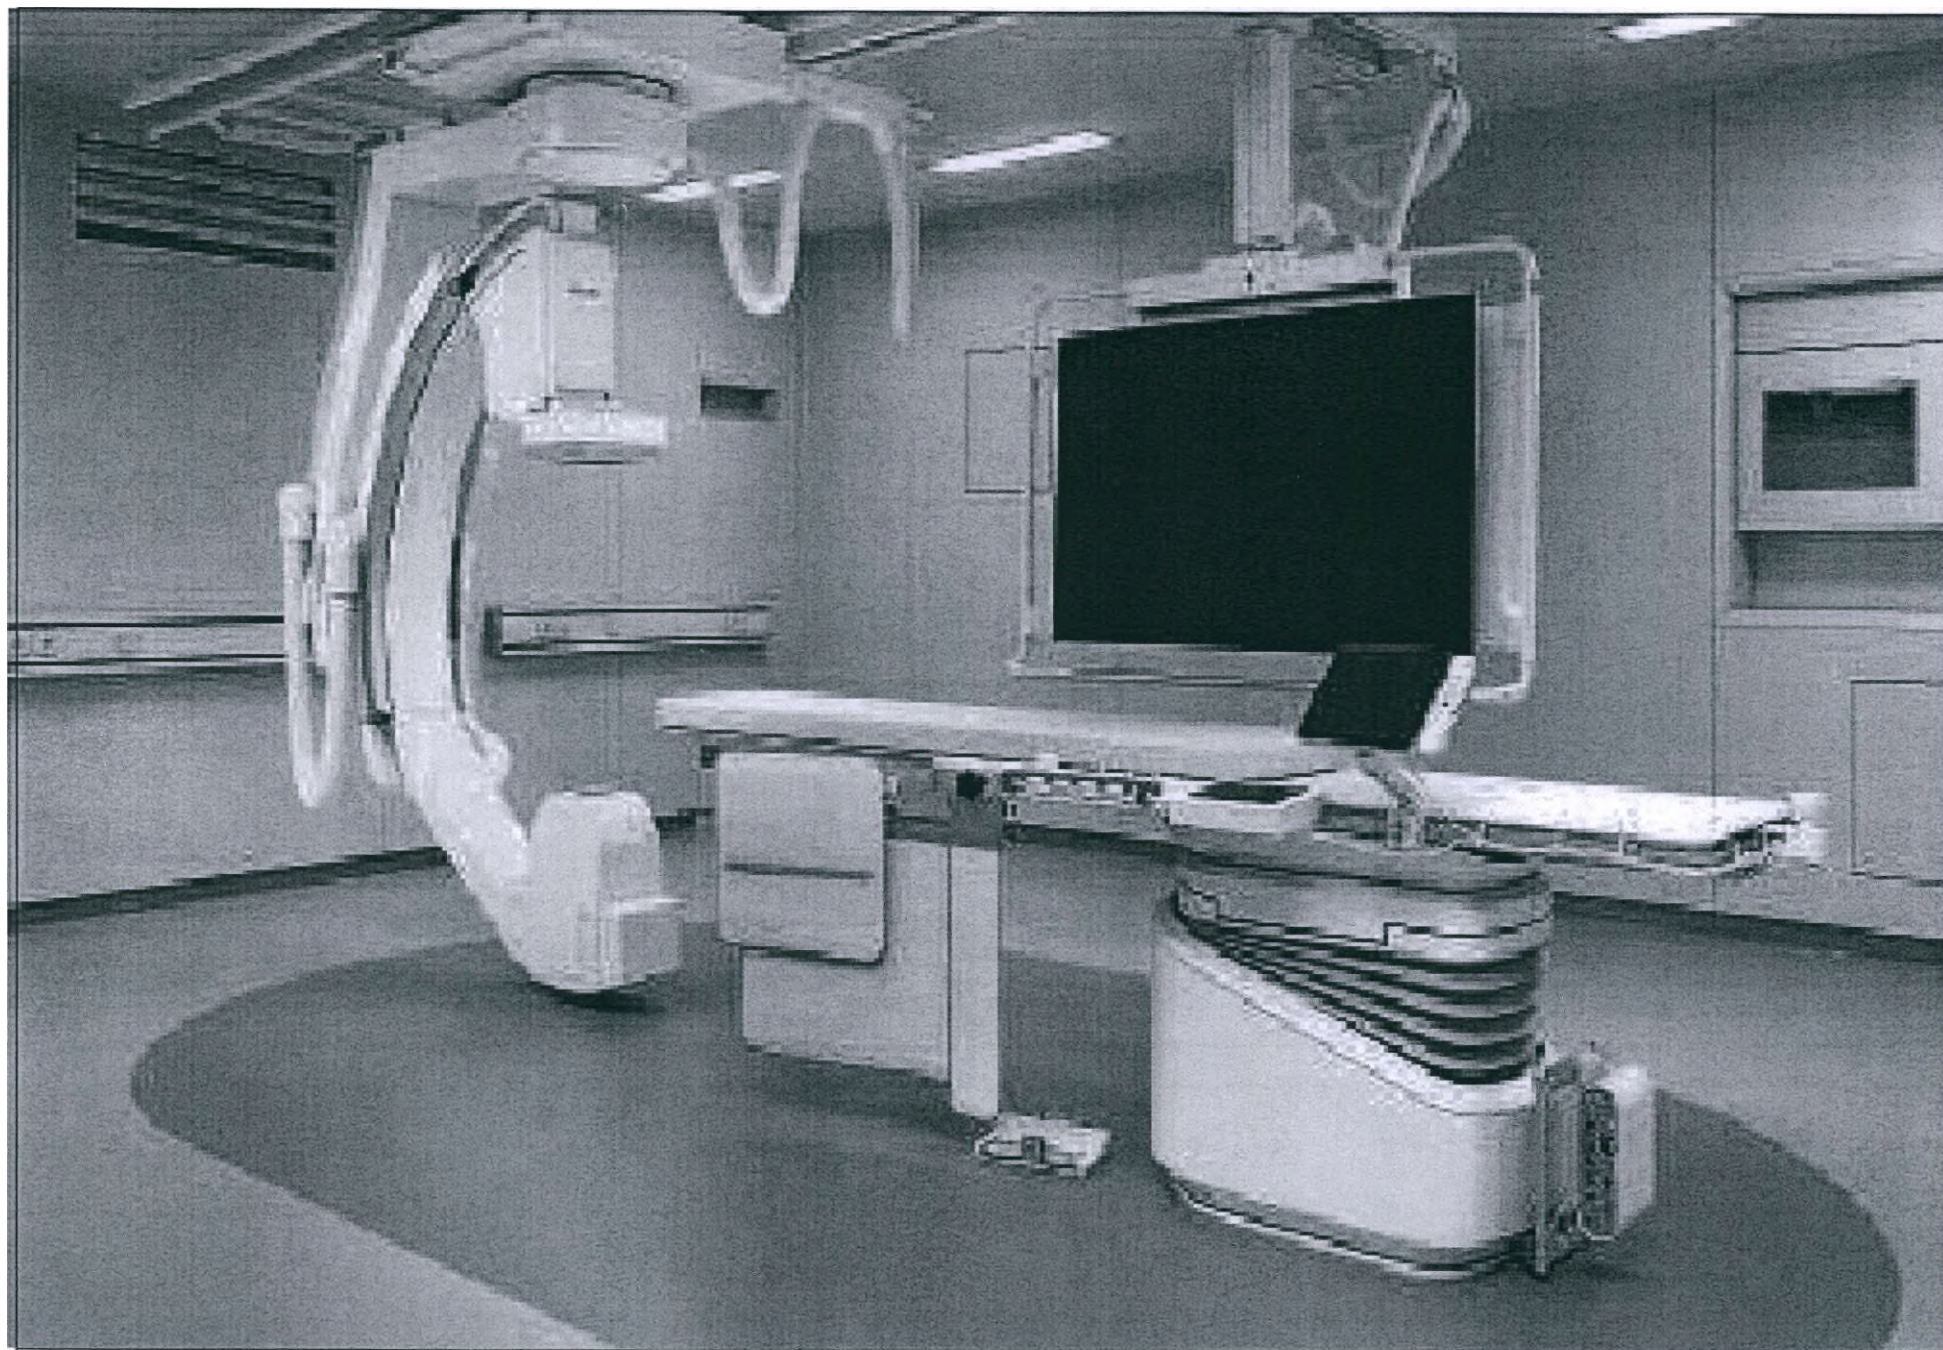

Общий вид медицинского изделия. Система Azurion вариант исполнения с потолочным креплением С-дуги.

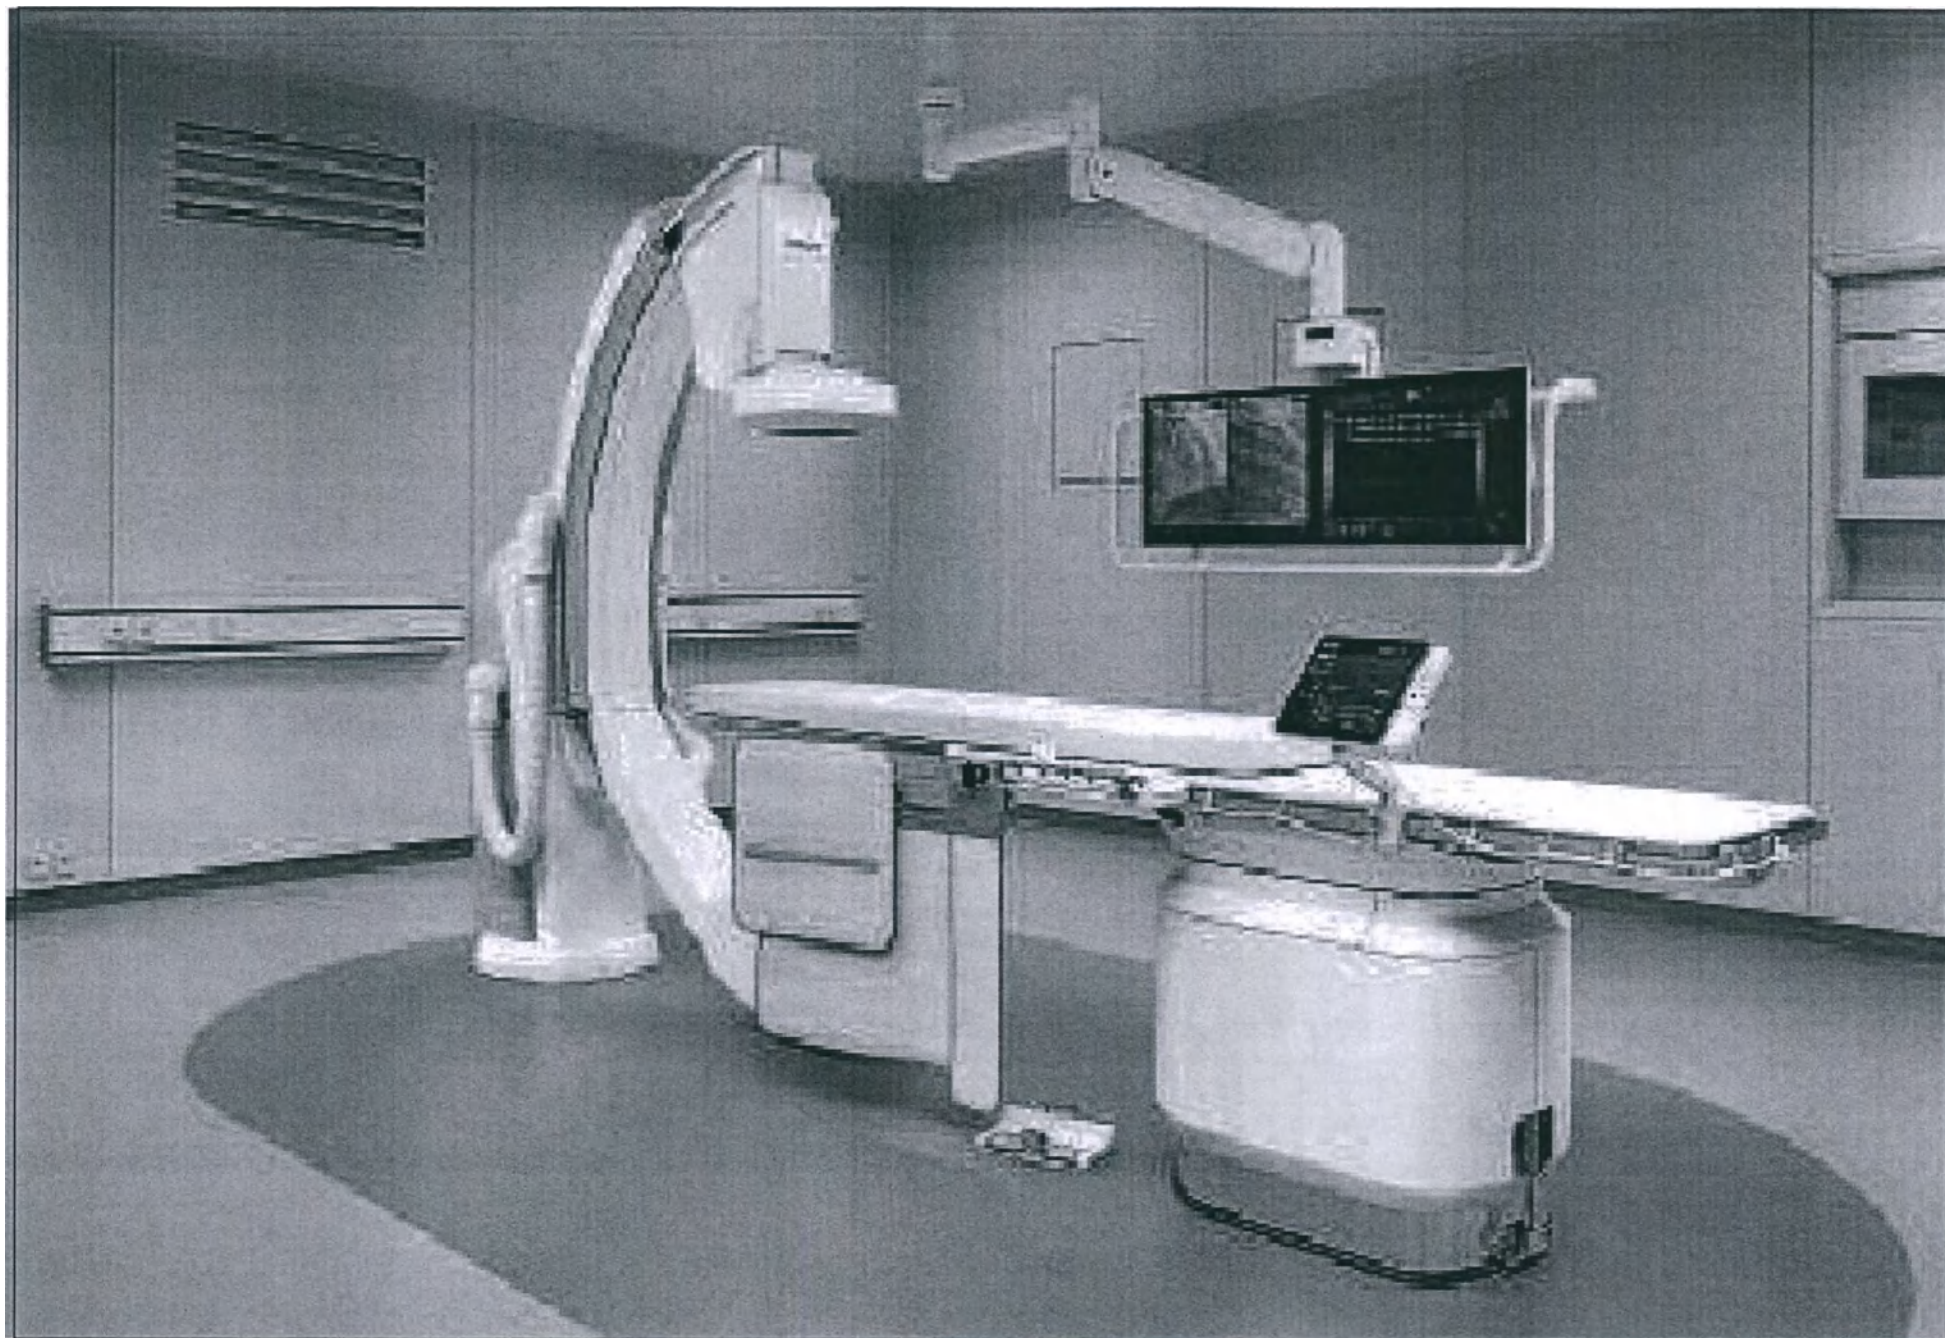


Общий вид медицинского изделия. Система Azurion вариант исполнения с напольным креплением С-дуги.

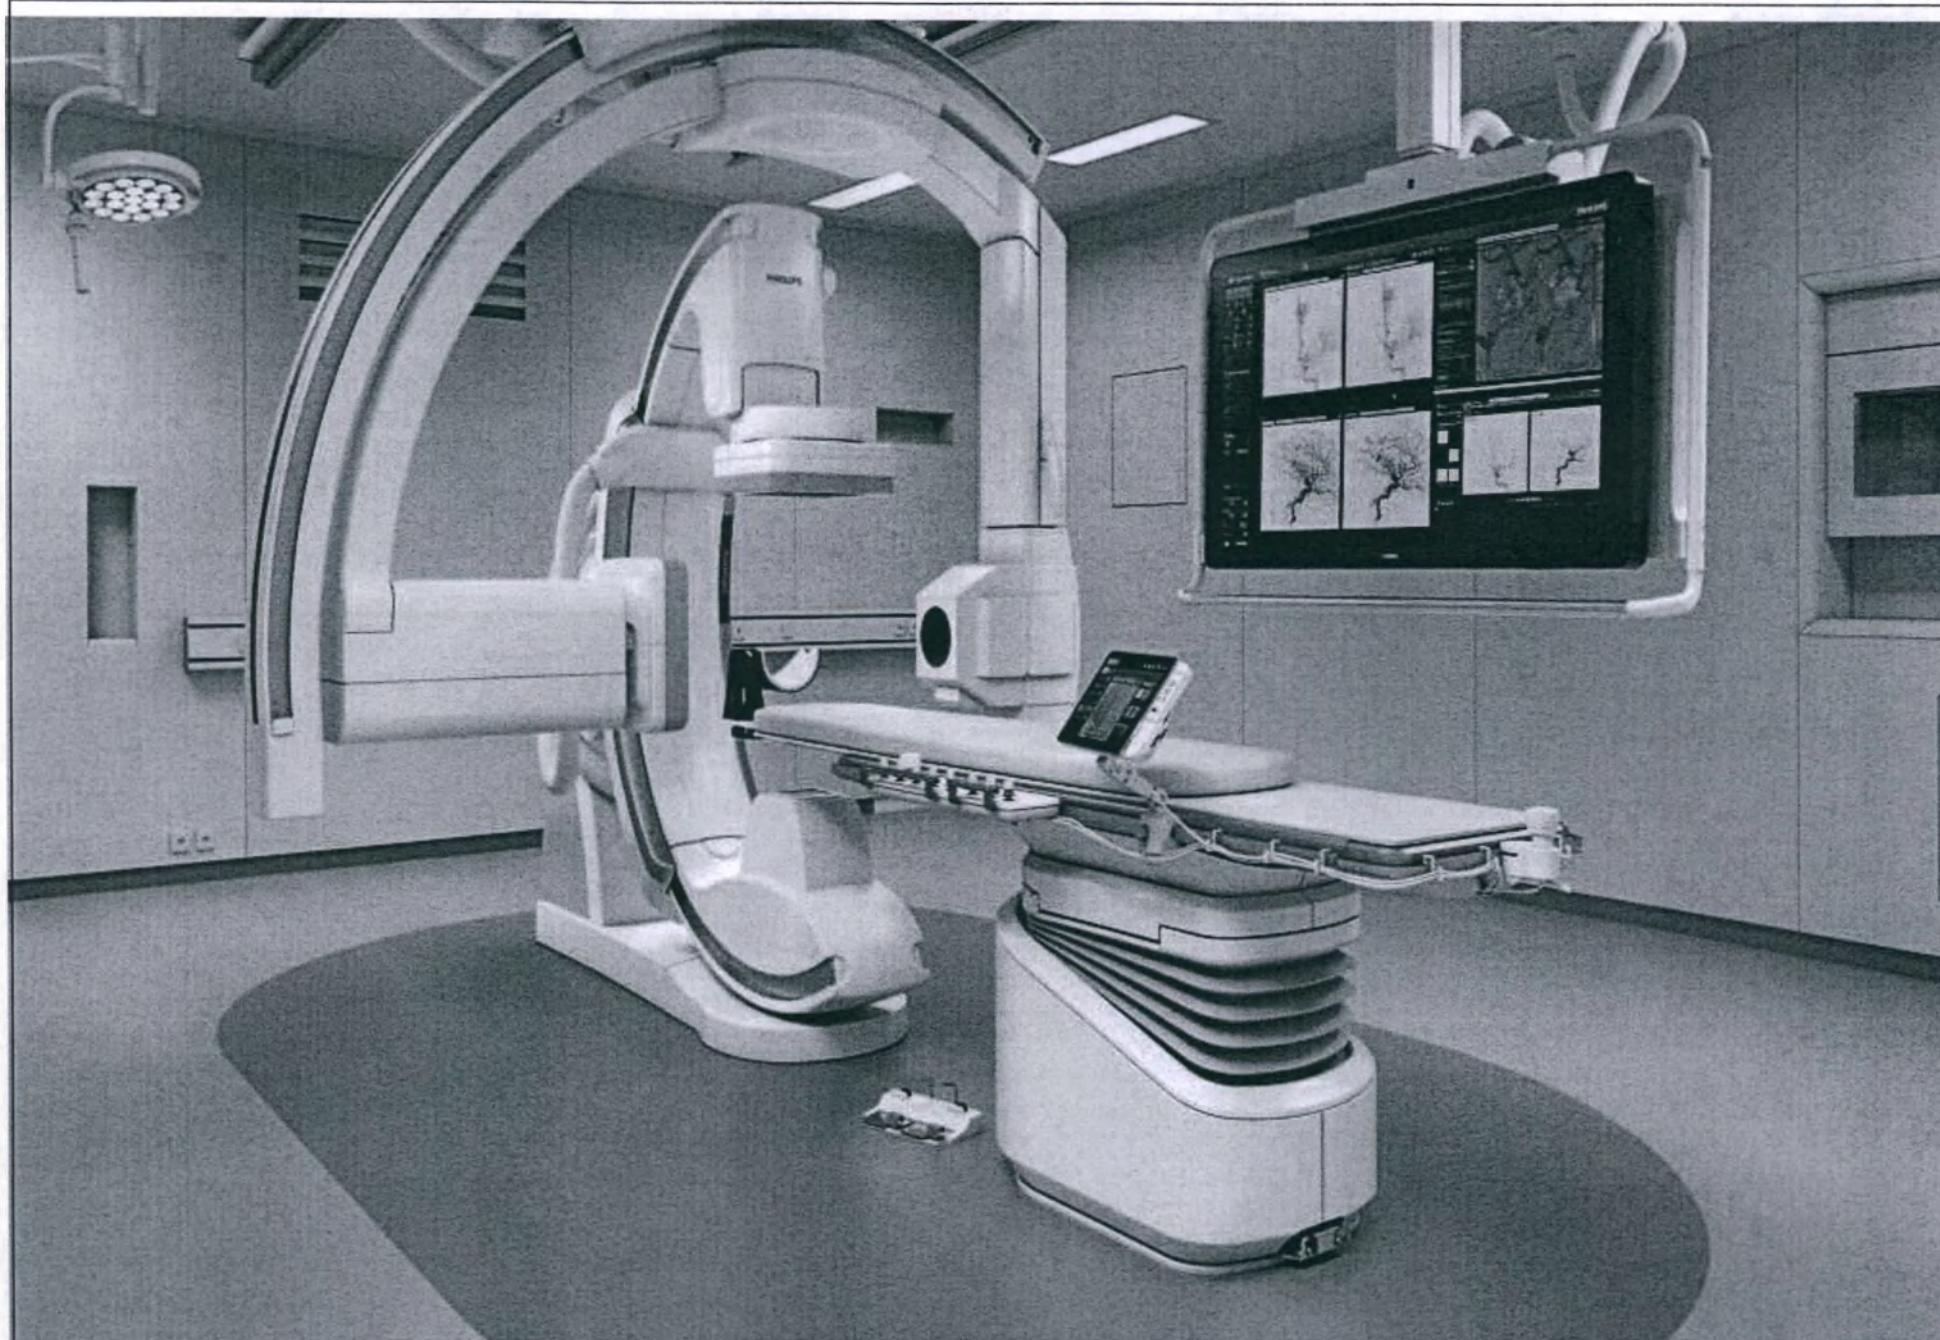


Общий вид медицинского изделия. Система Azurion, двухпроекторный вариант исполнения.


Система ангиографическая Azurion 3 M12:

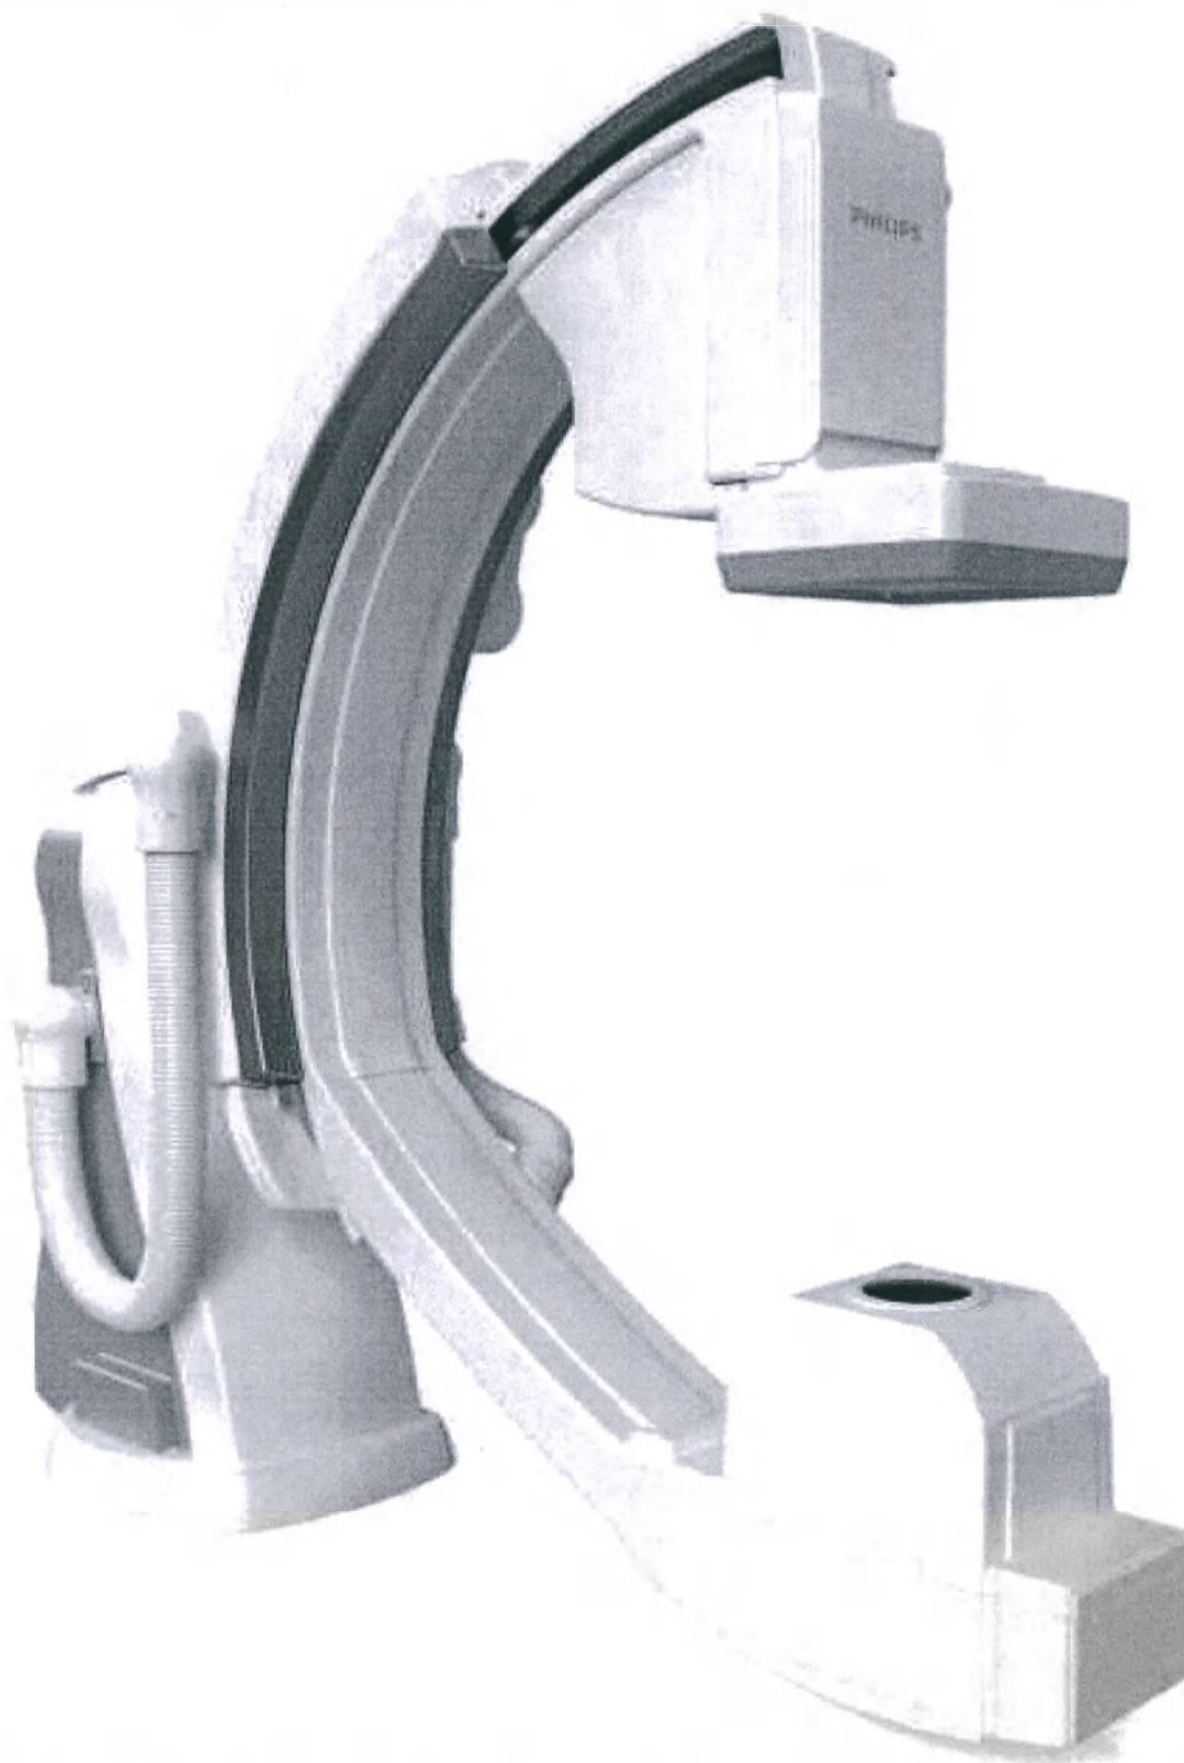


1. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

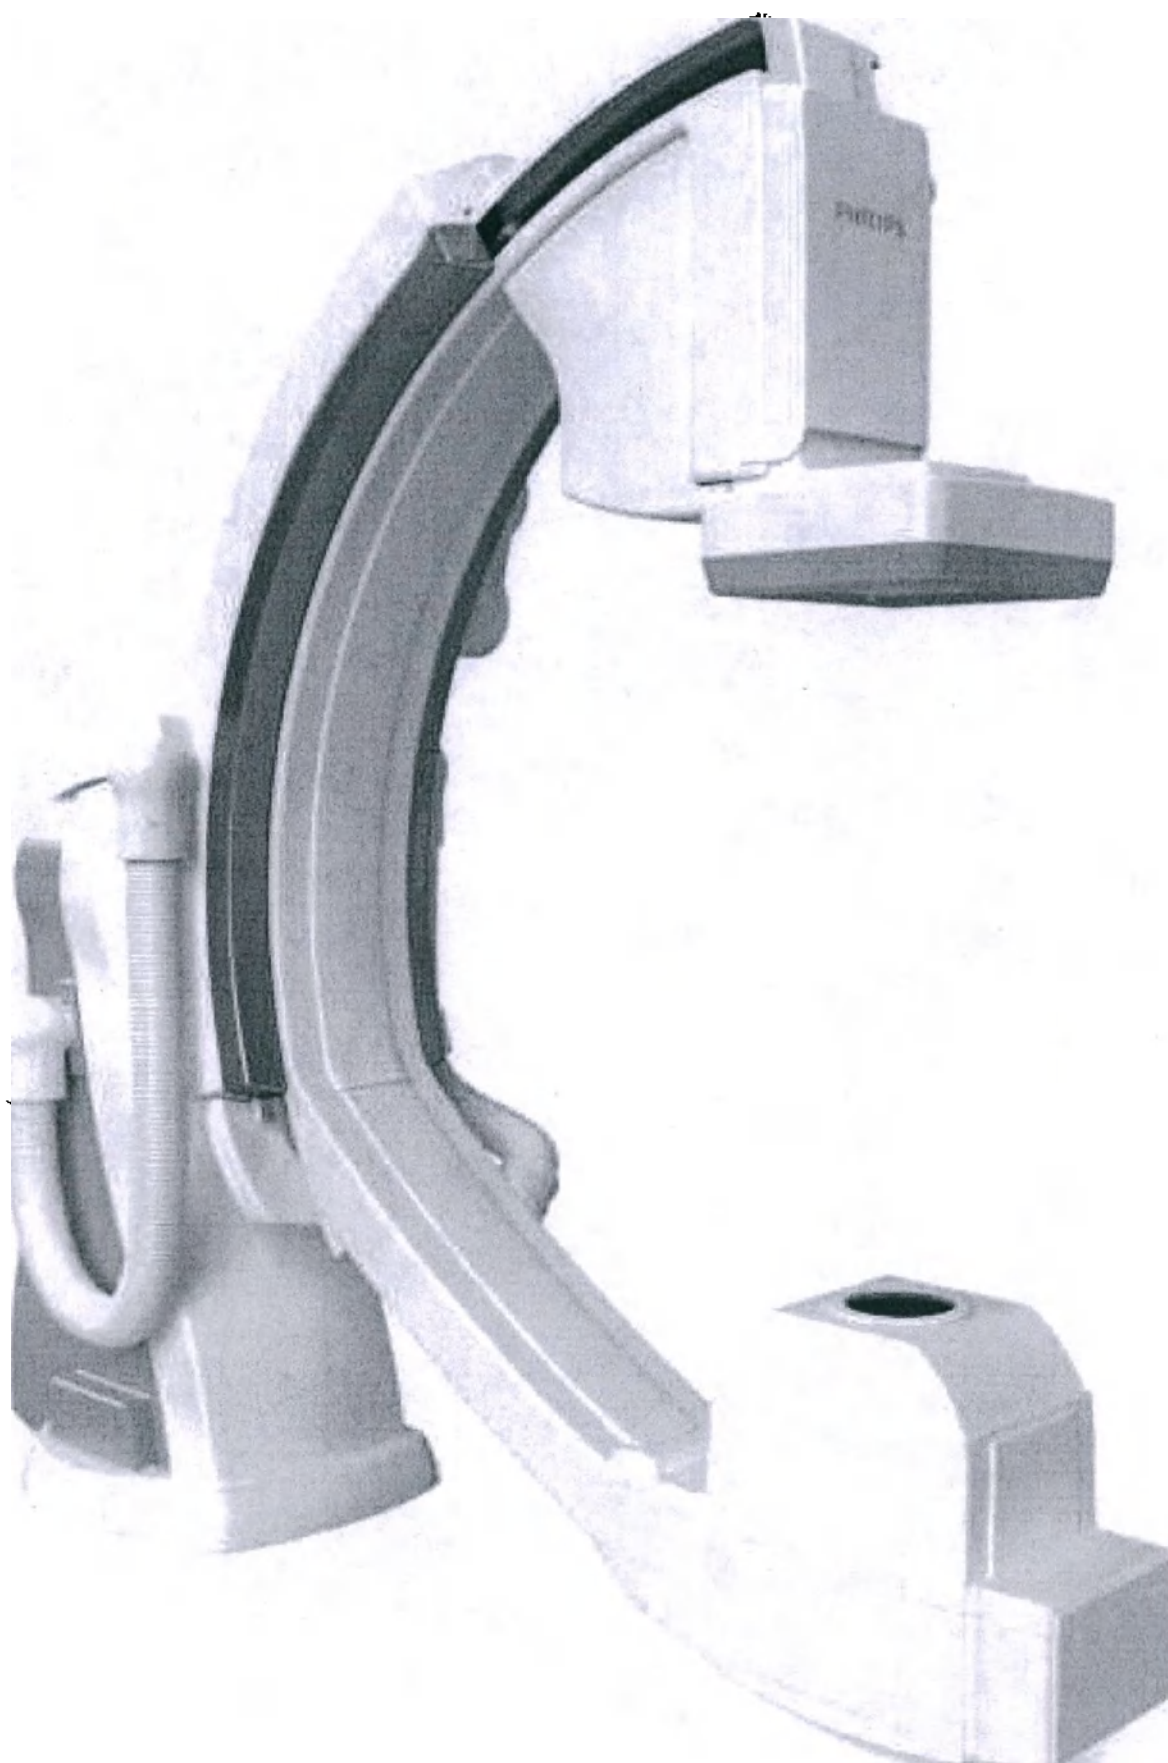


1.а. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

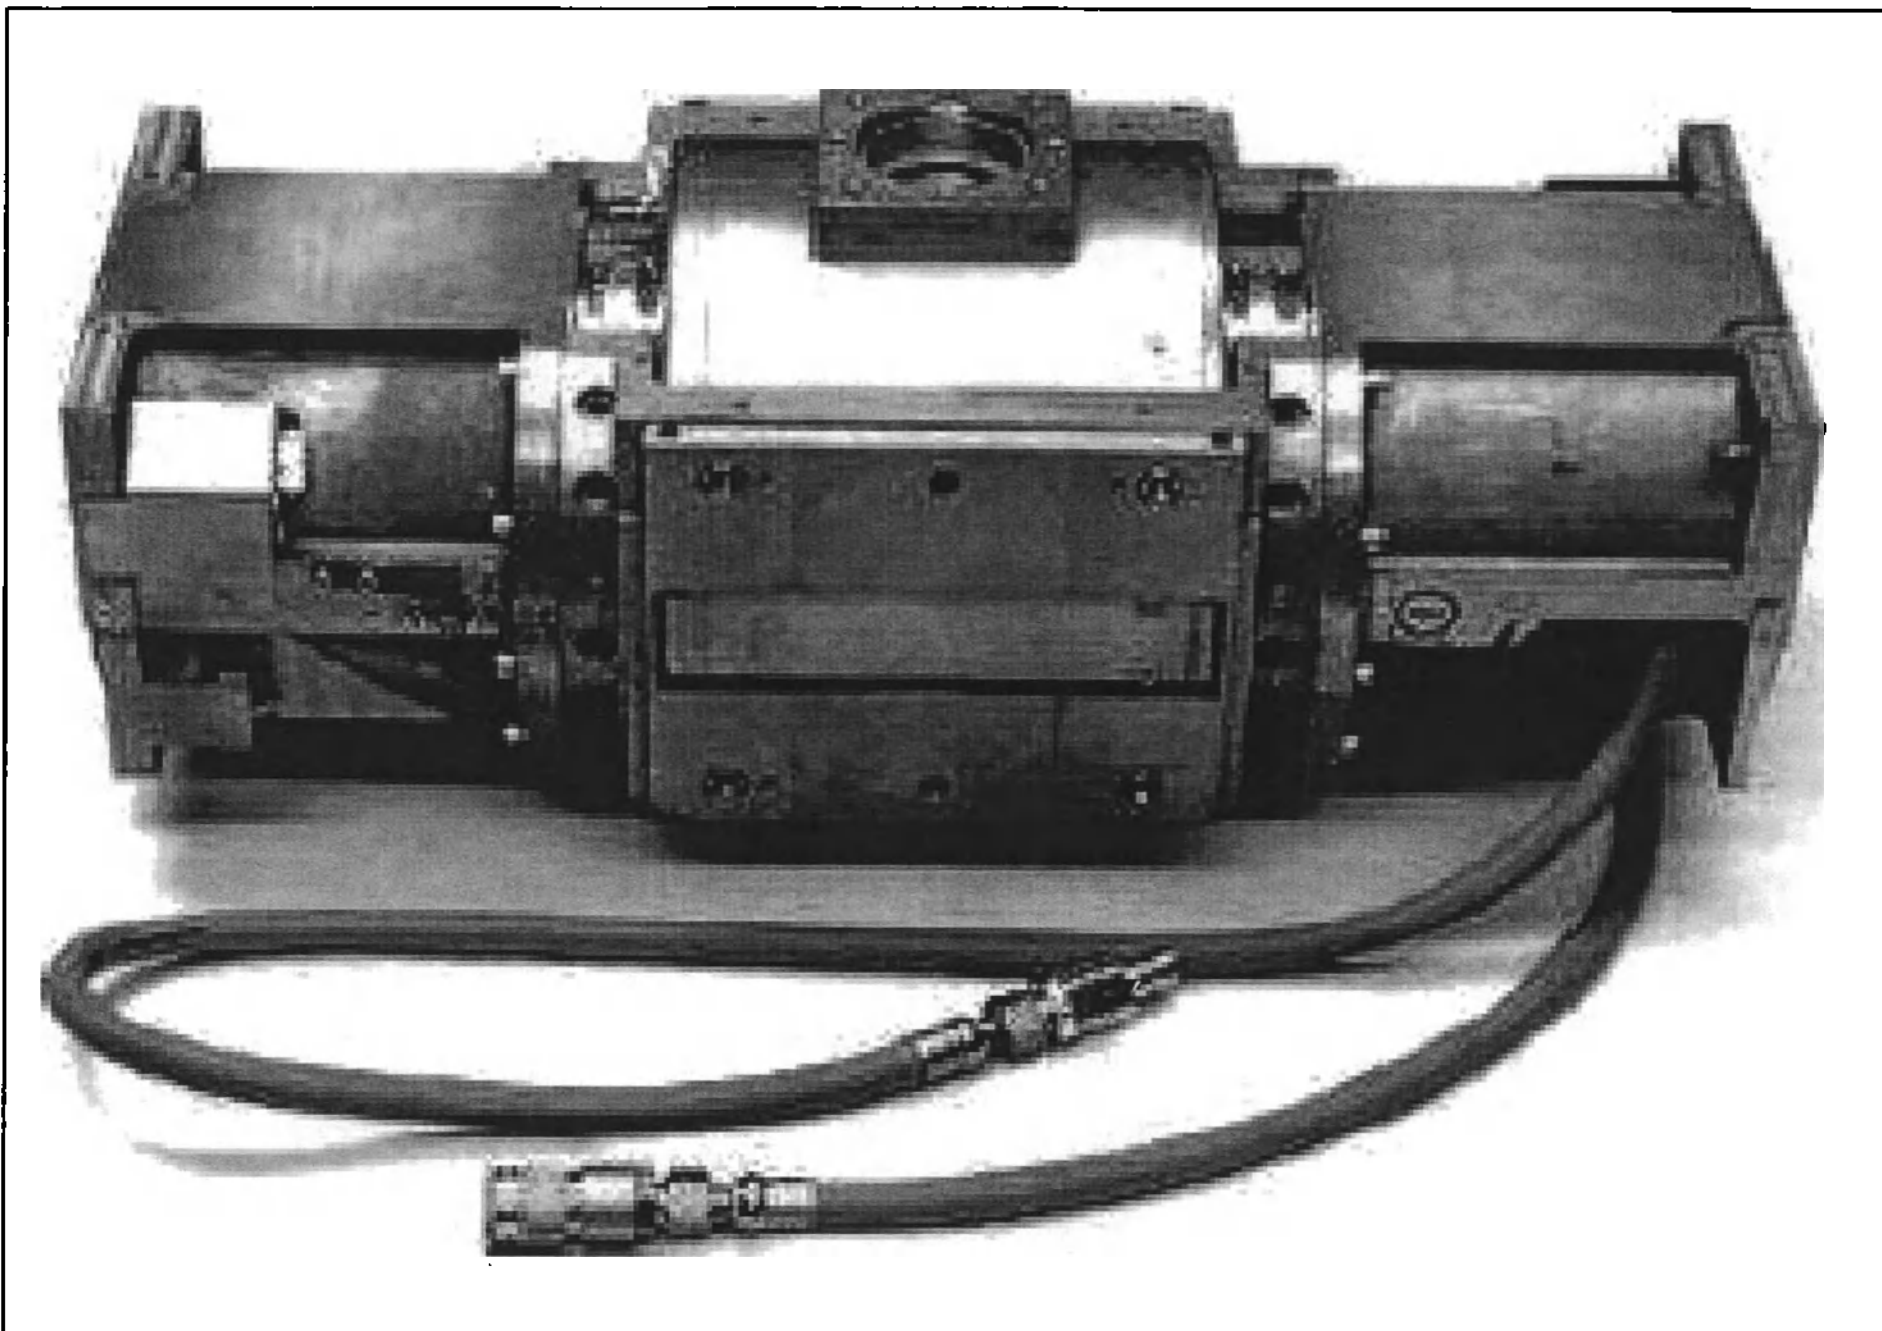


1.6. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

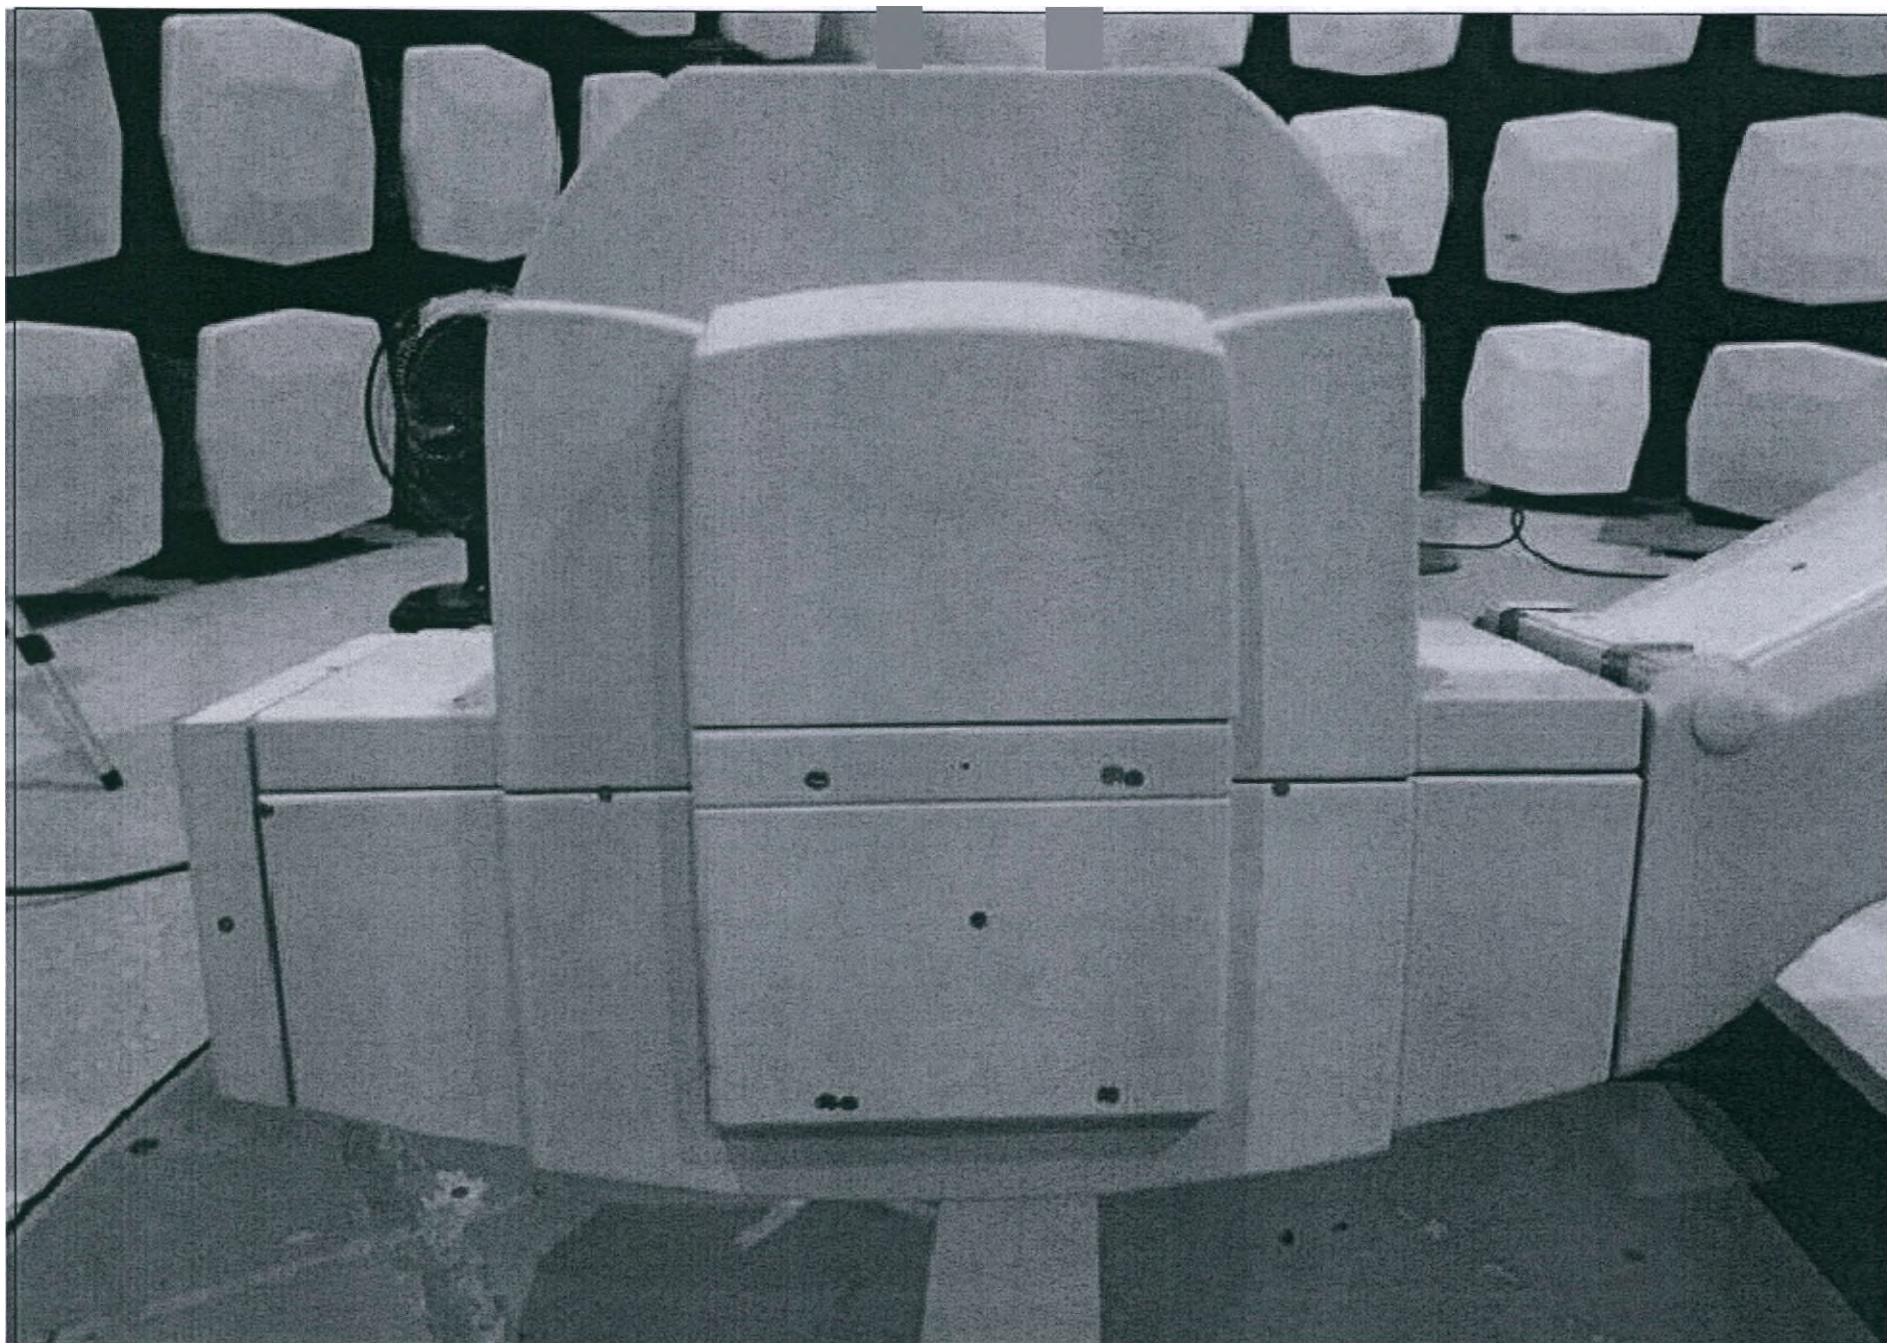


1.в. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

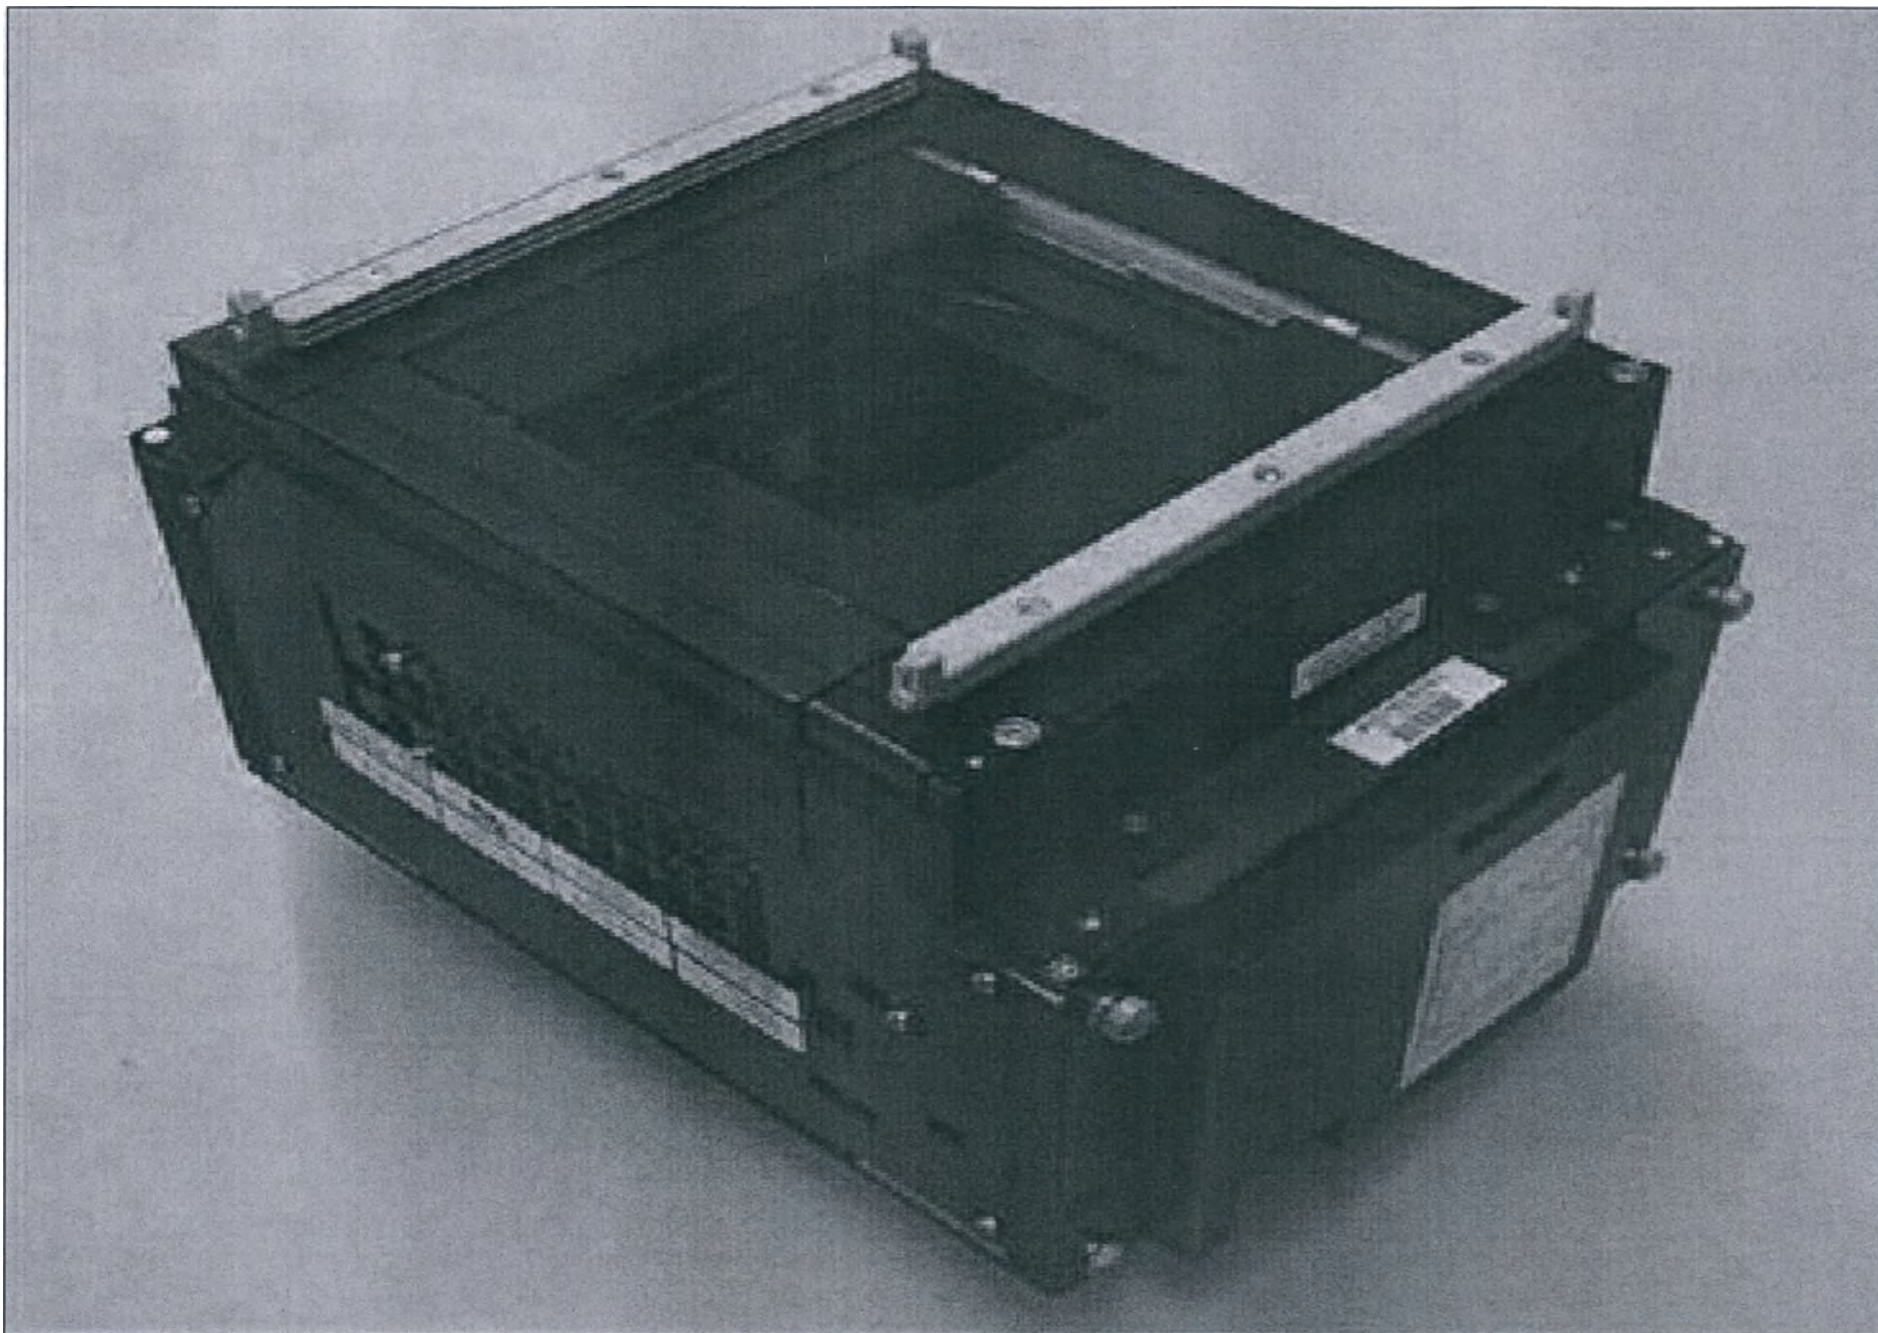


1.2. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

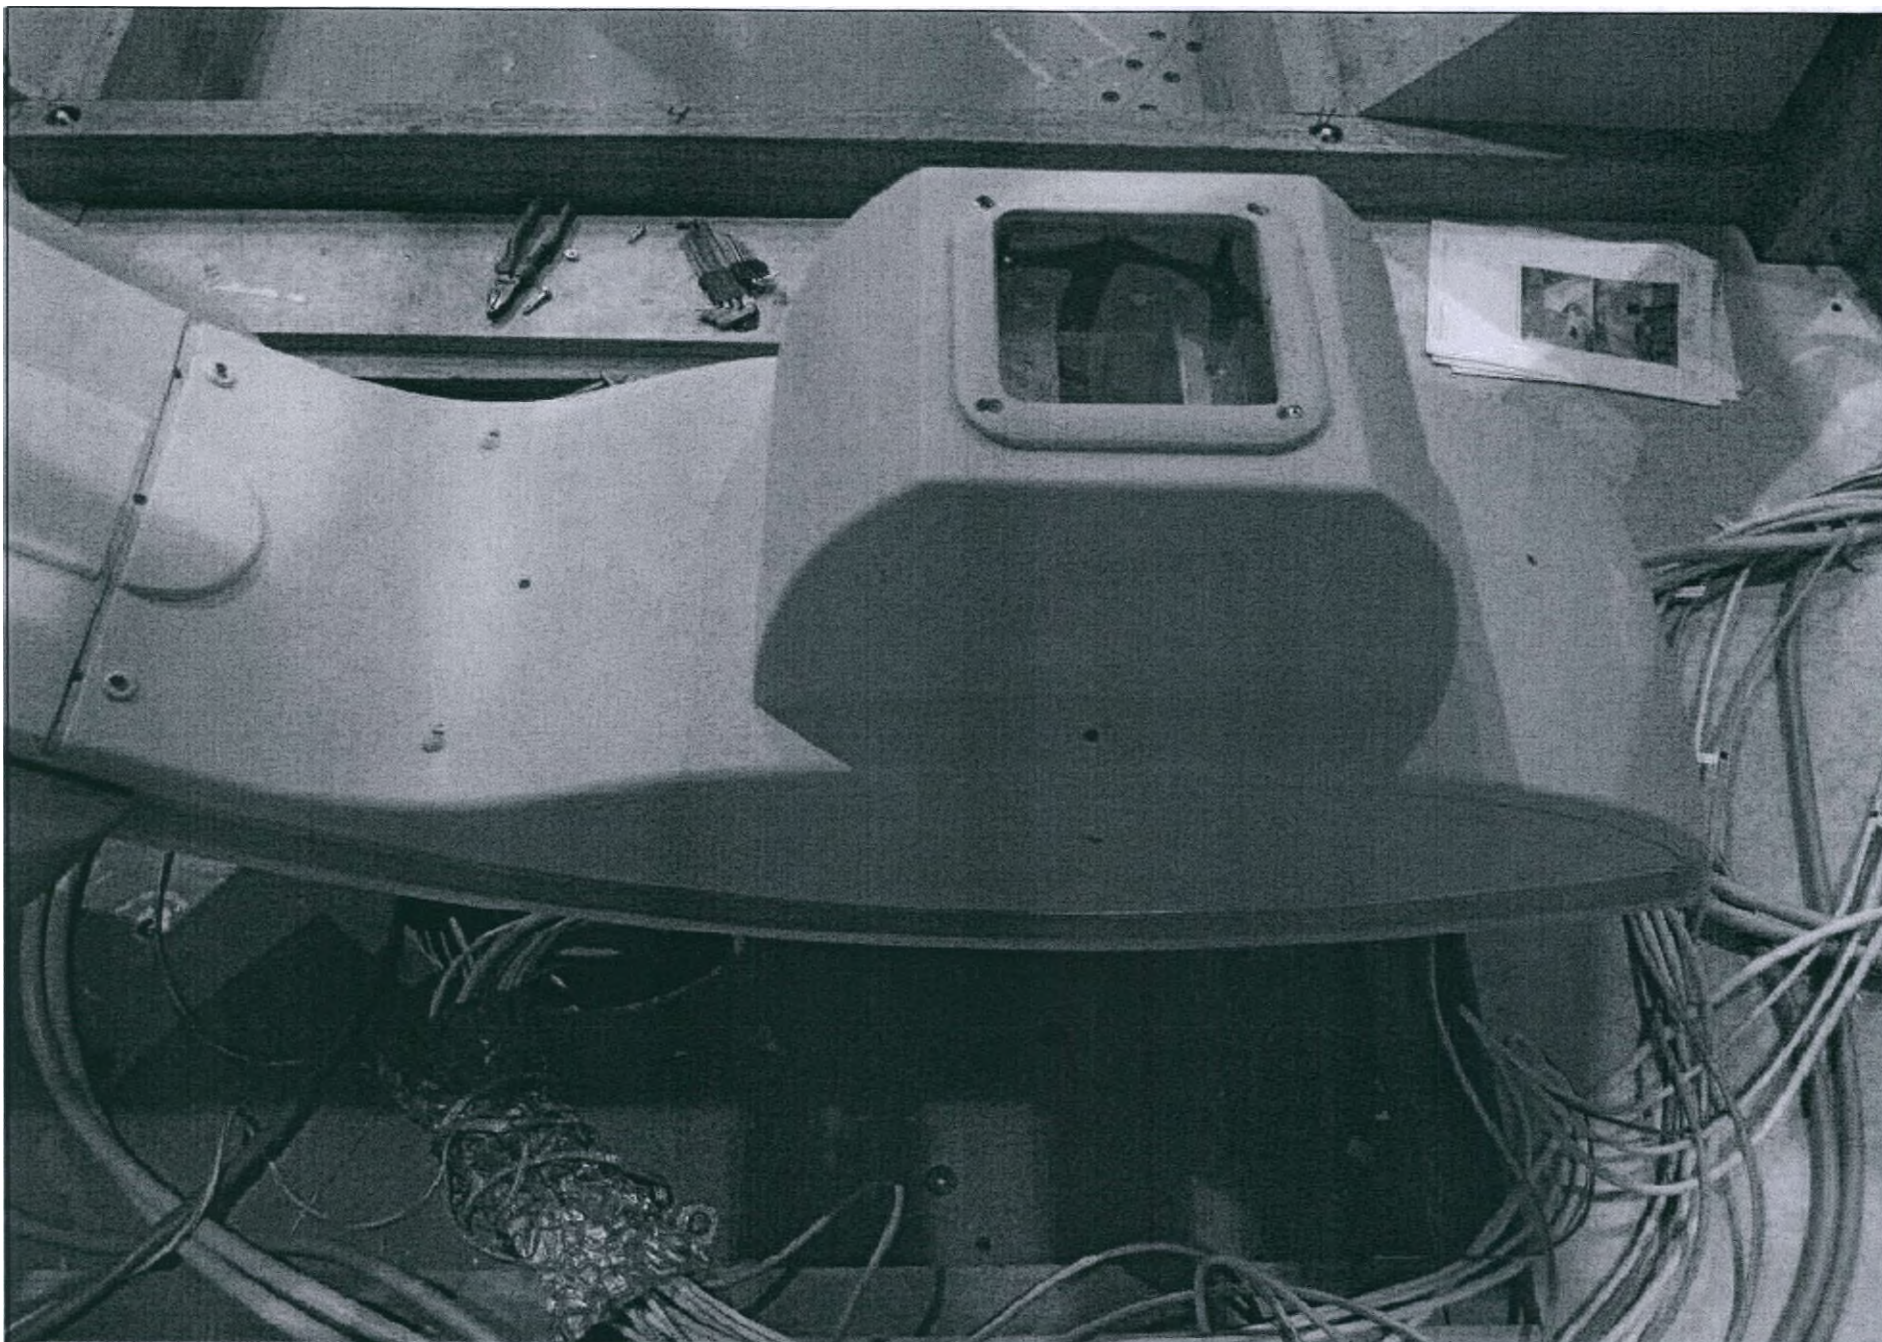


1.д. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

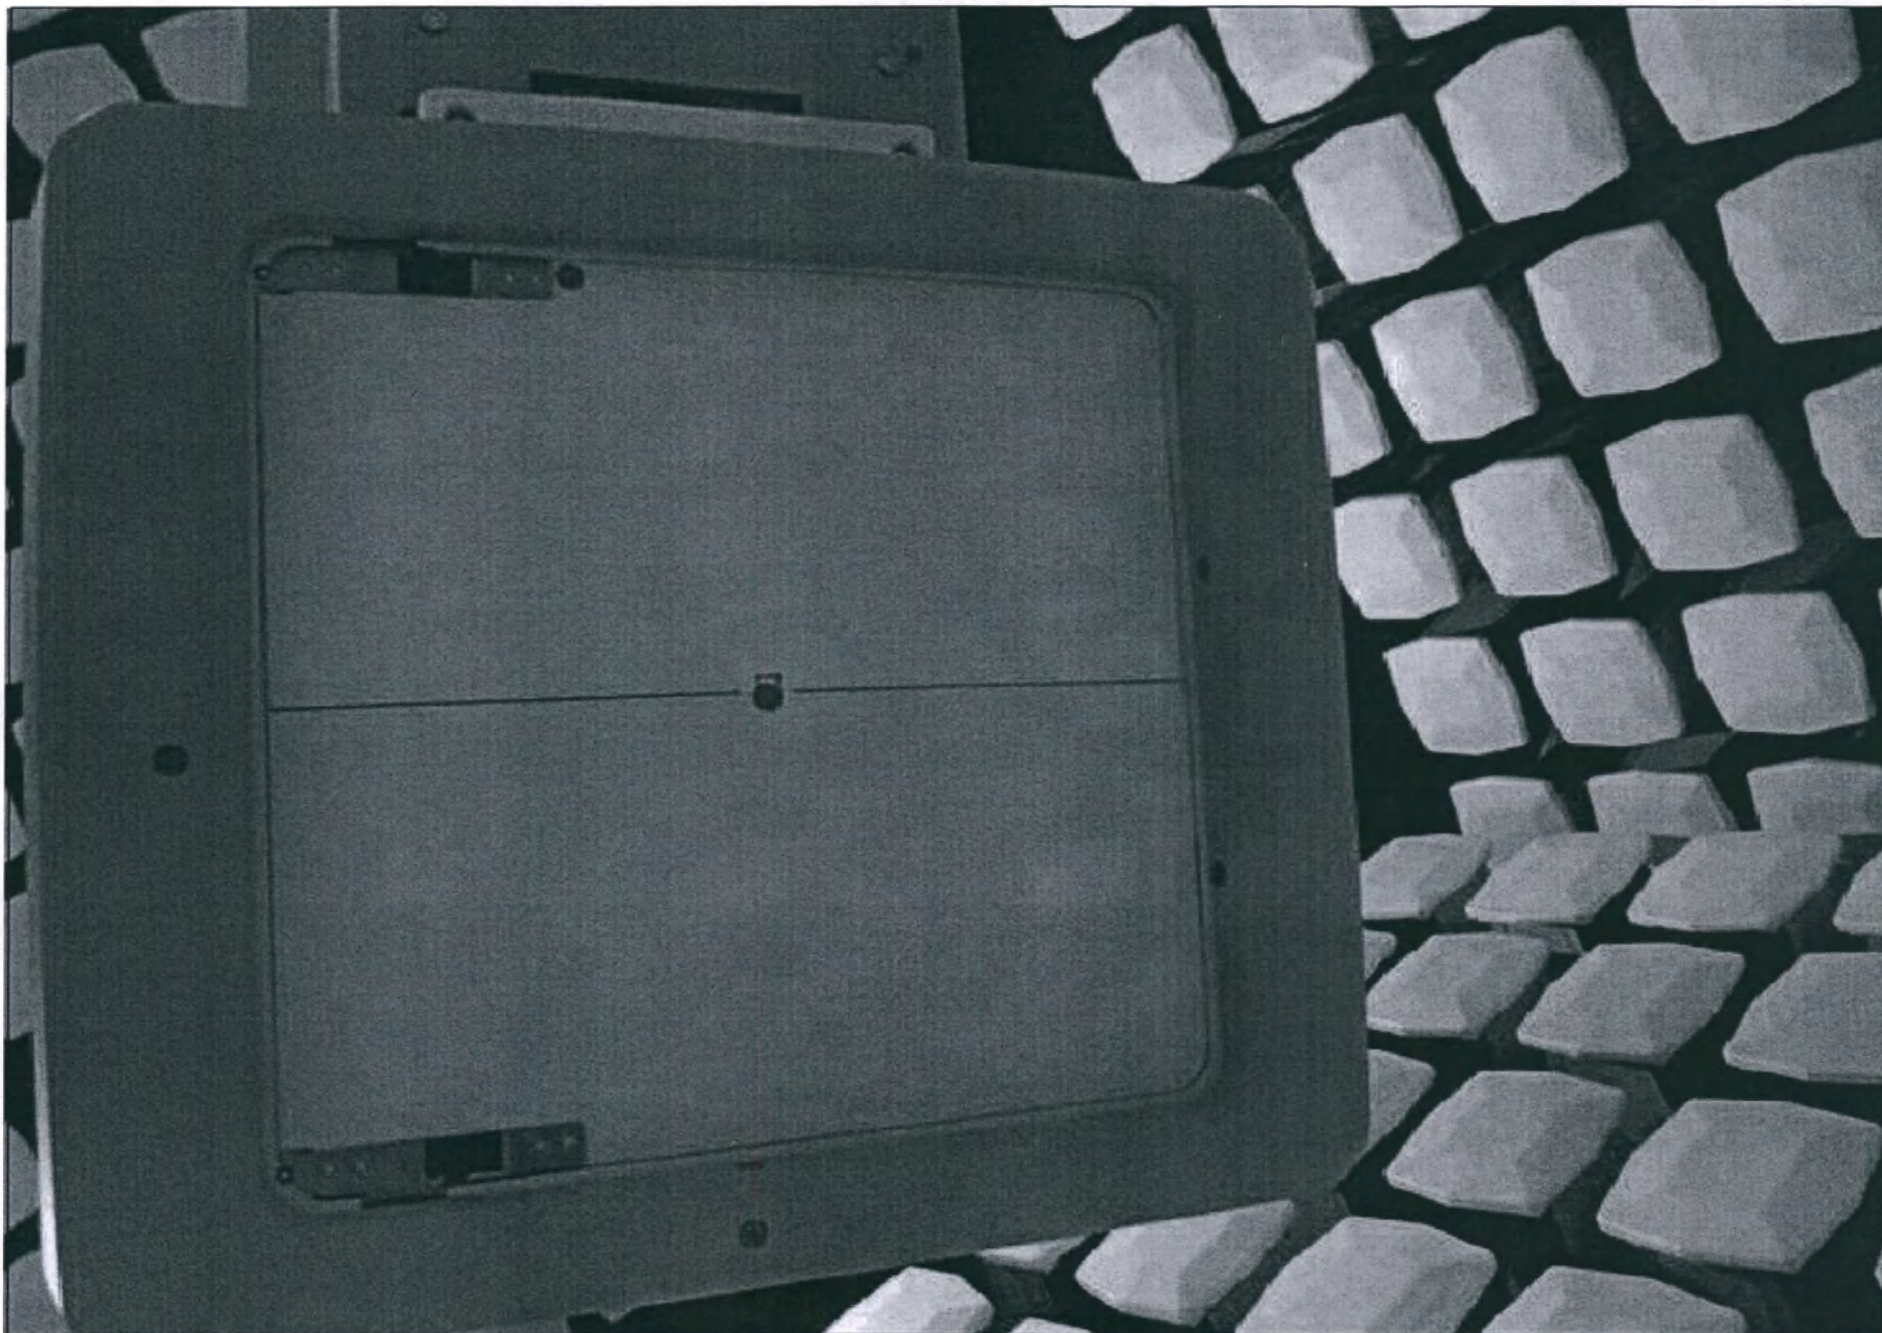


1.е Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

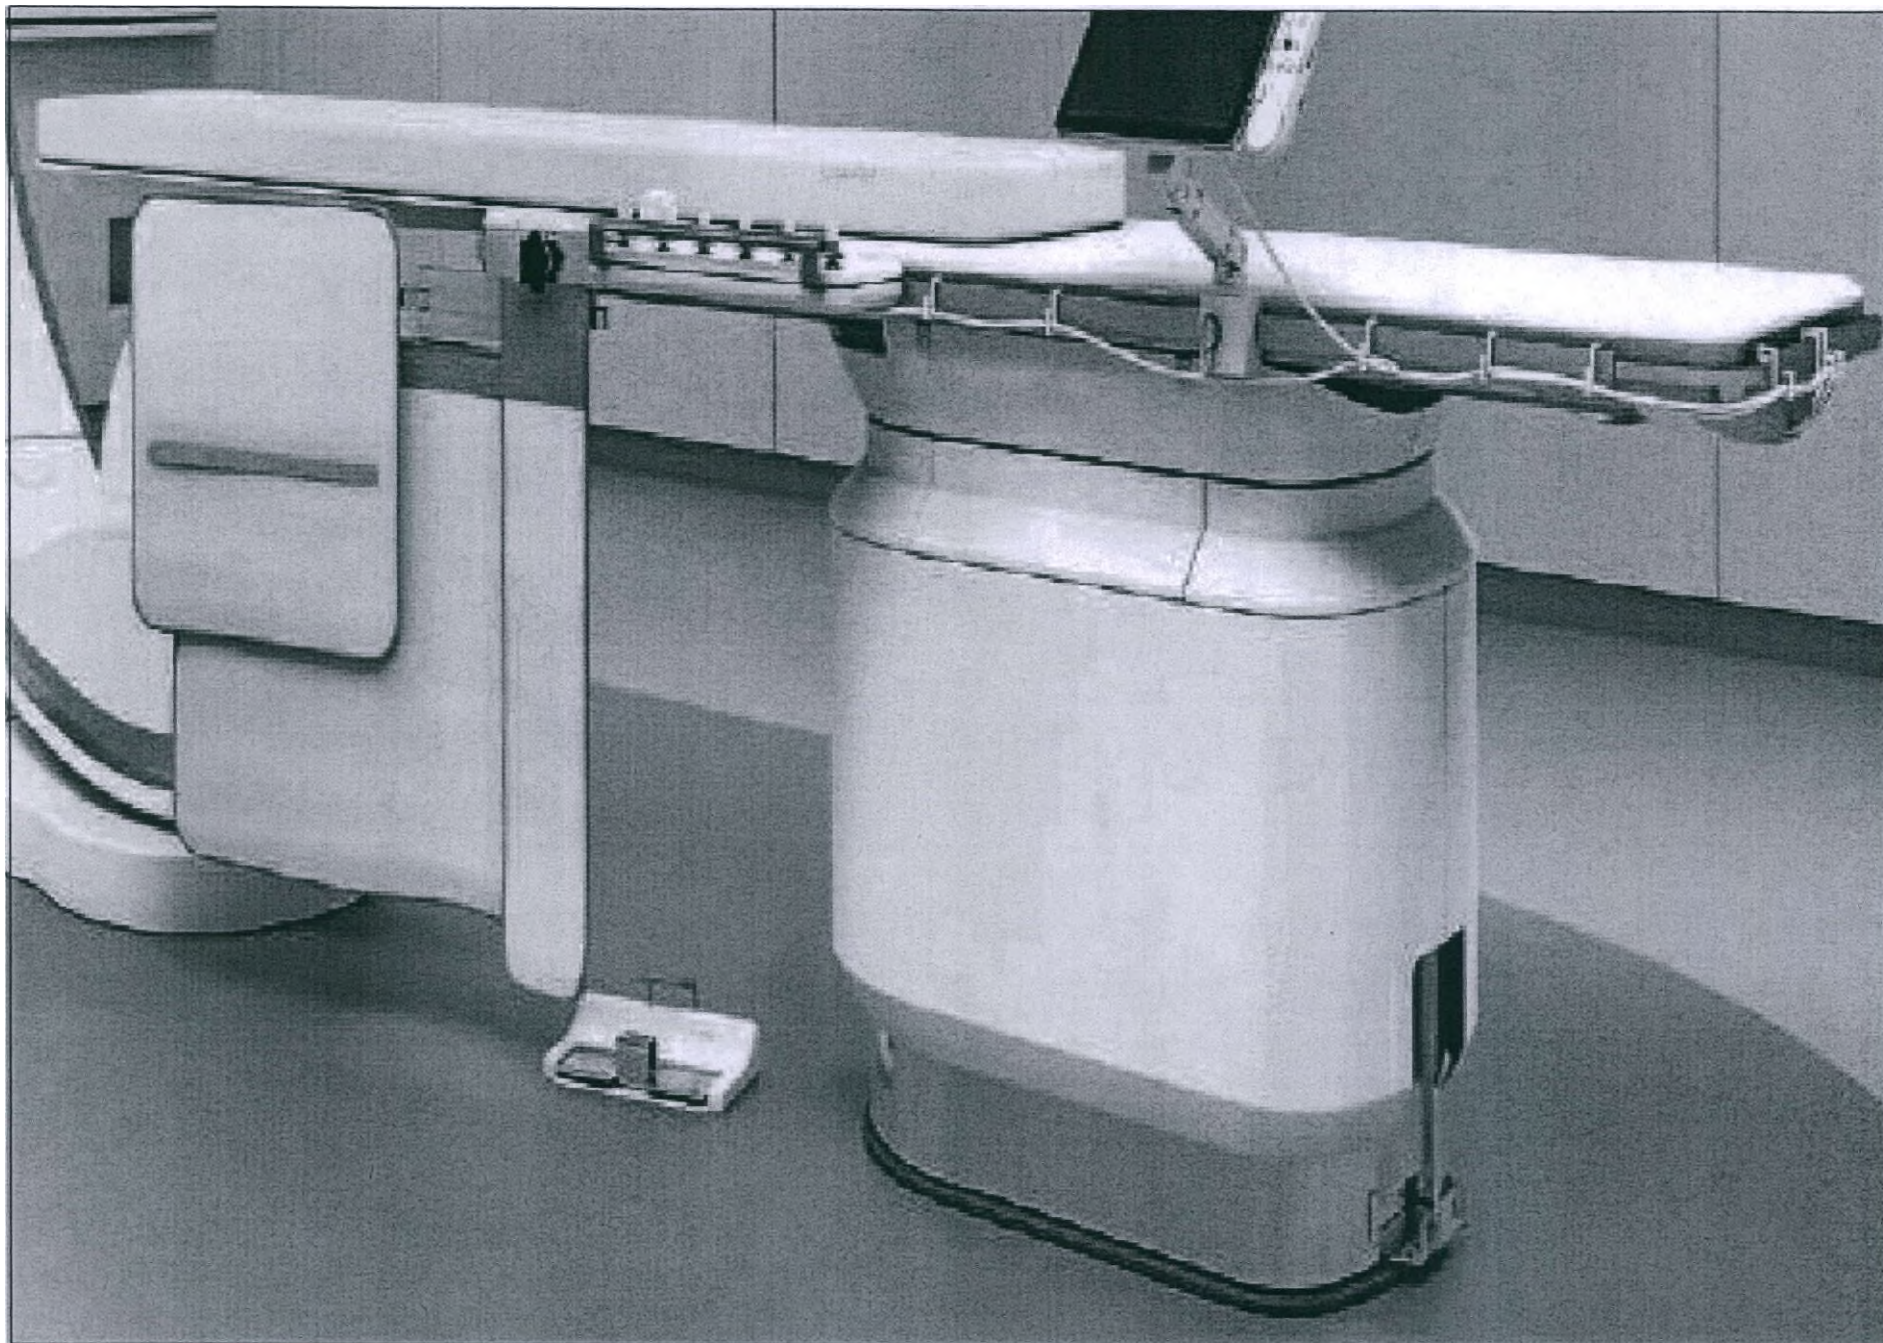


2.1. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

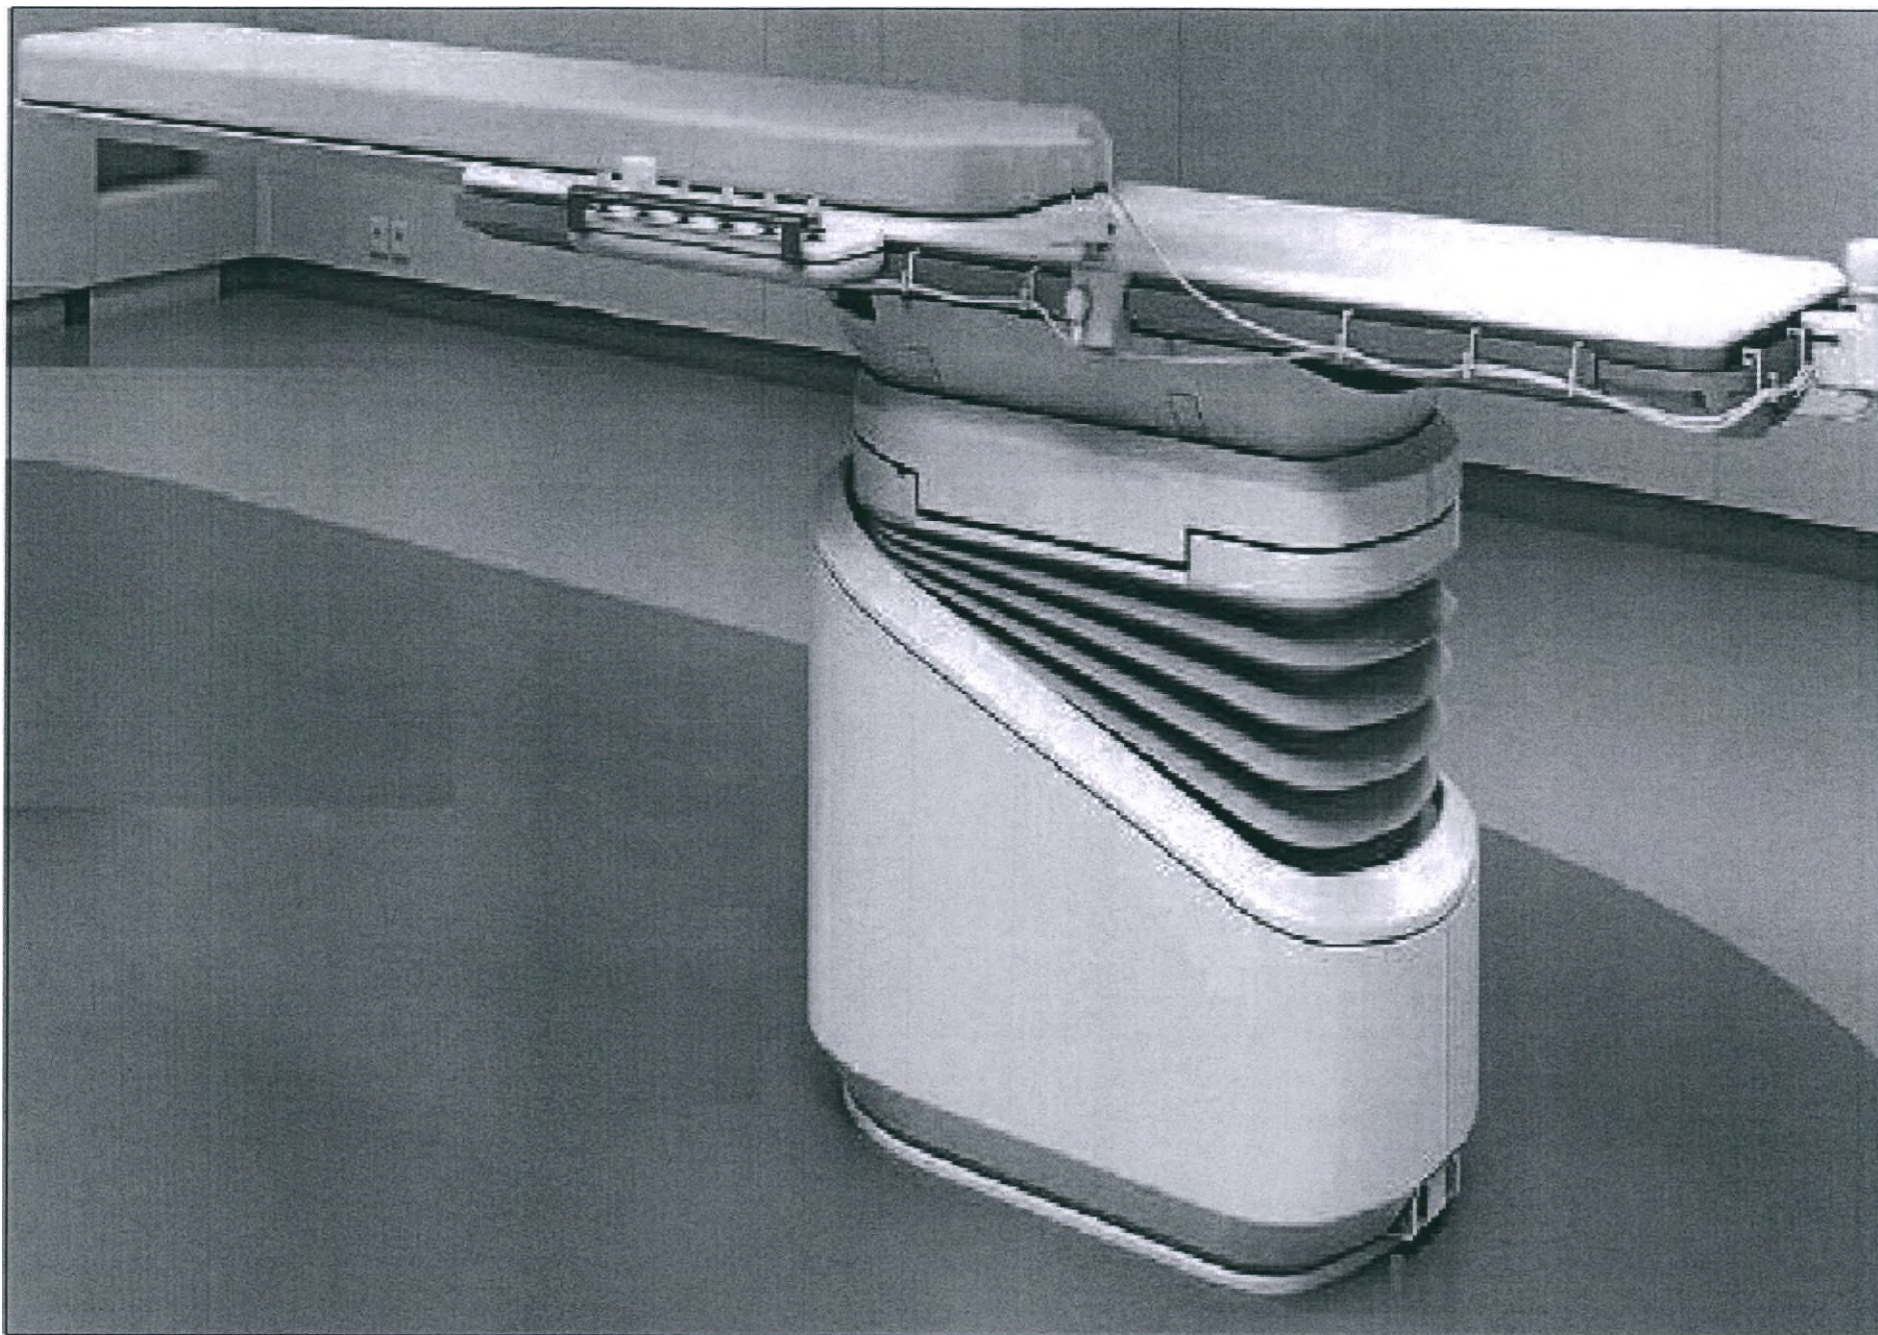


2.2. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

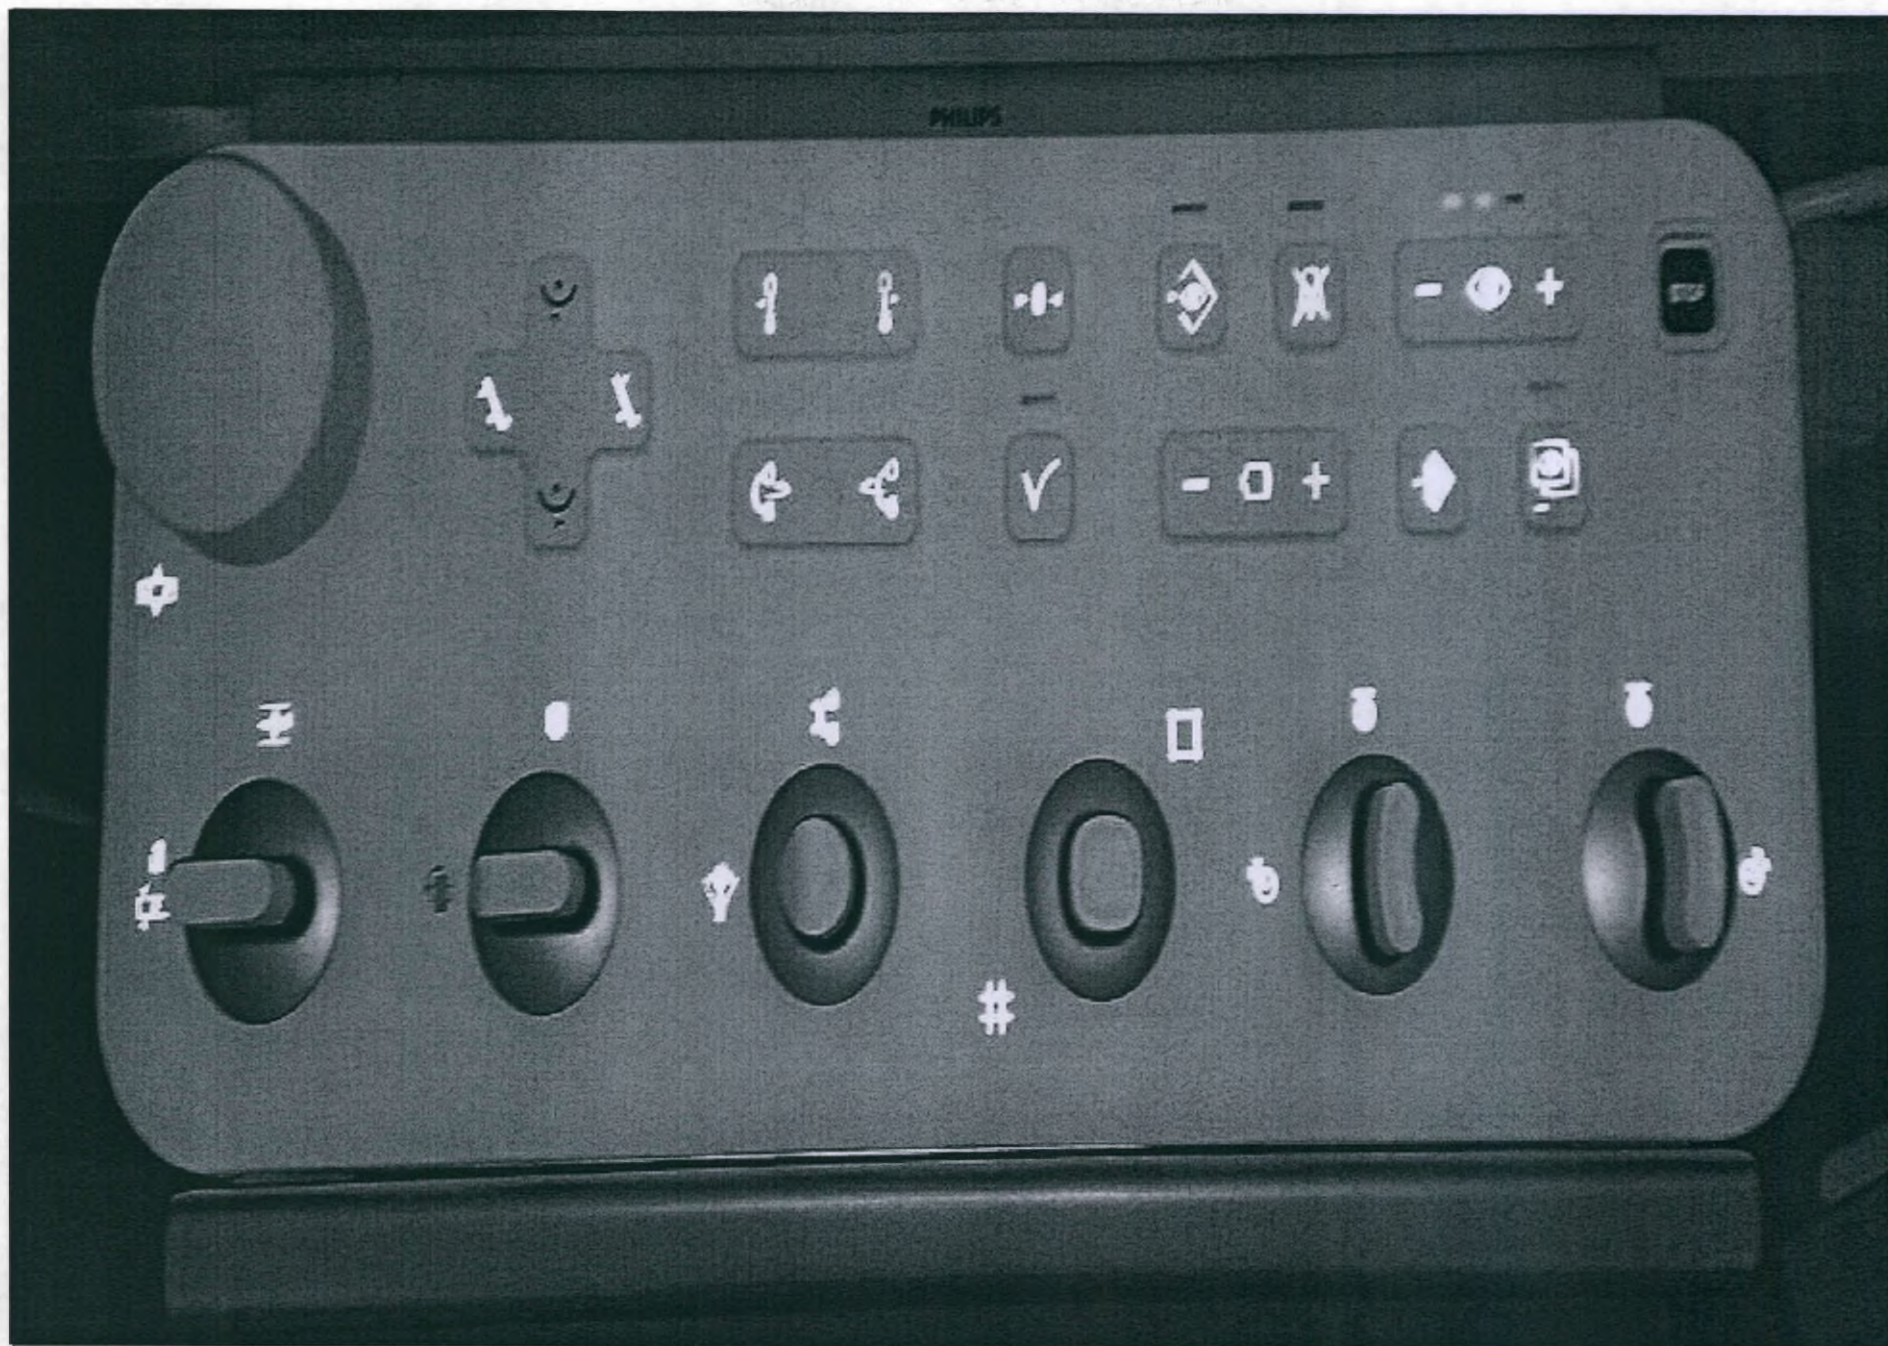


3. Модуль управления, не более 4 шт.

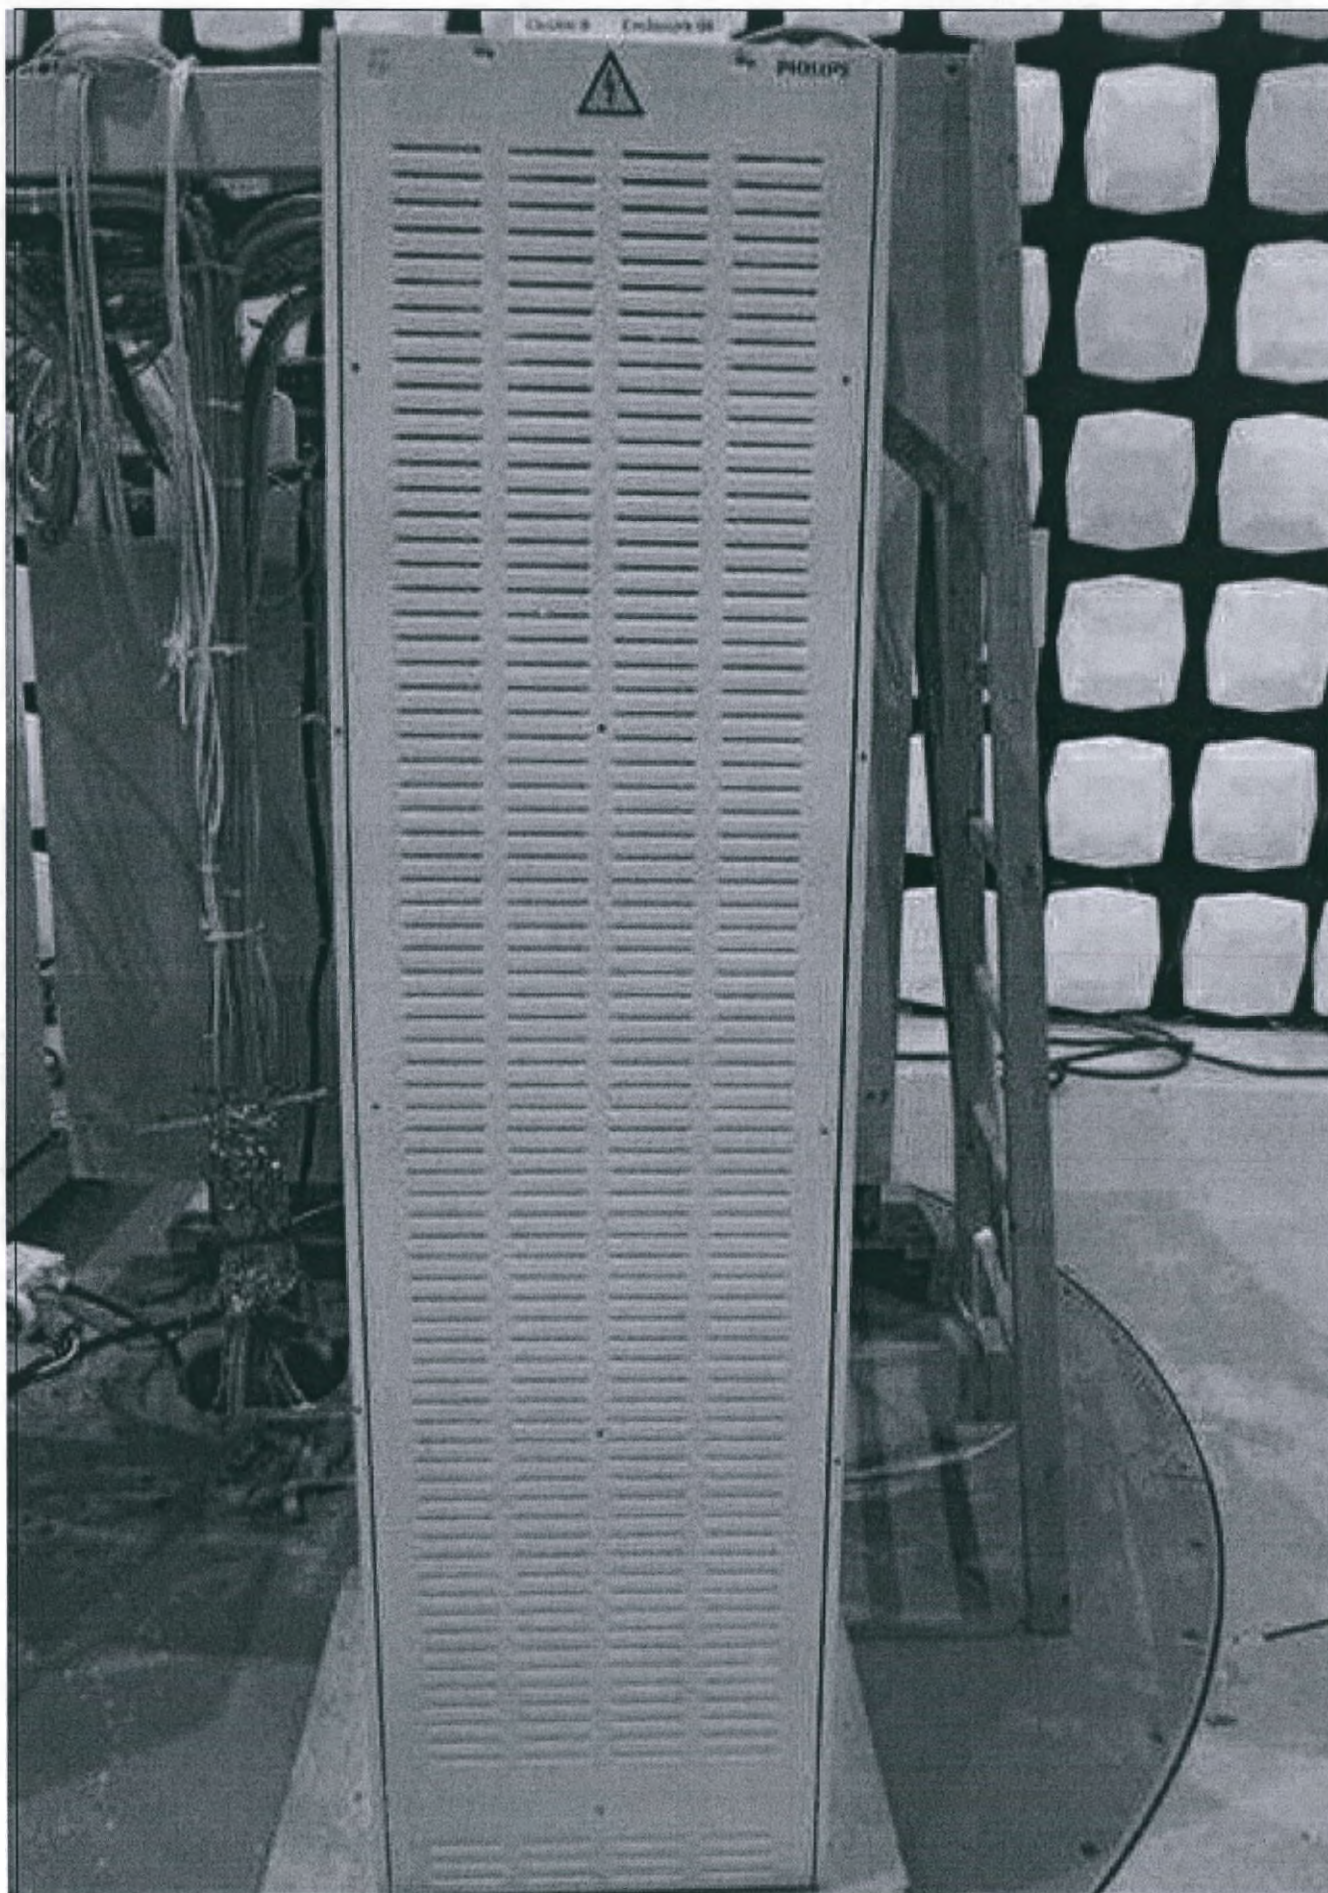


4.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

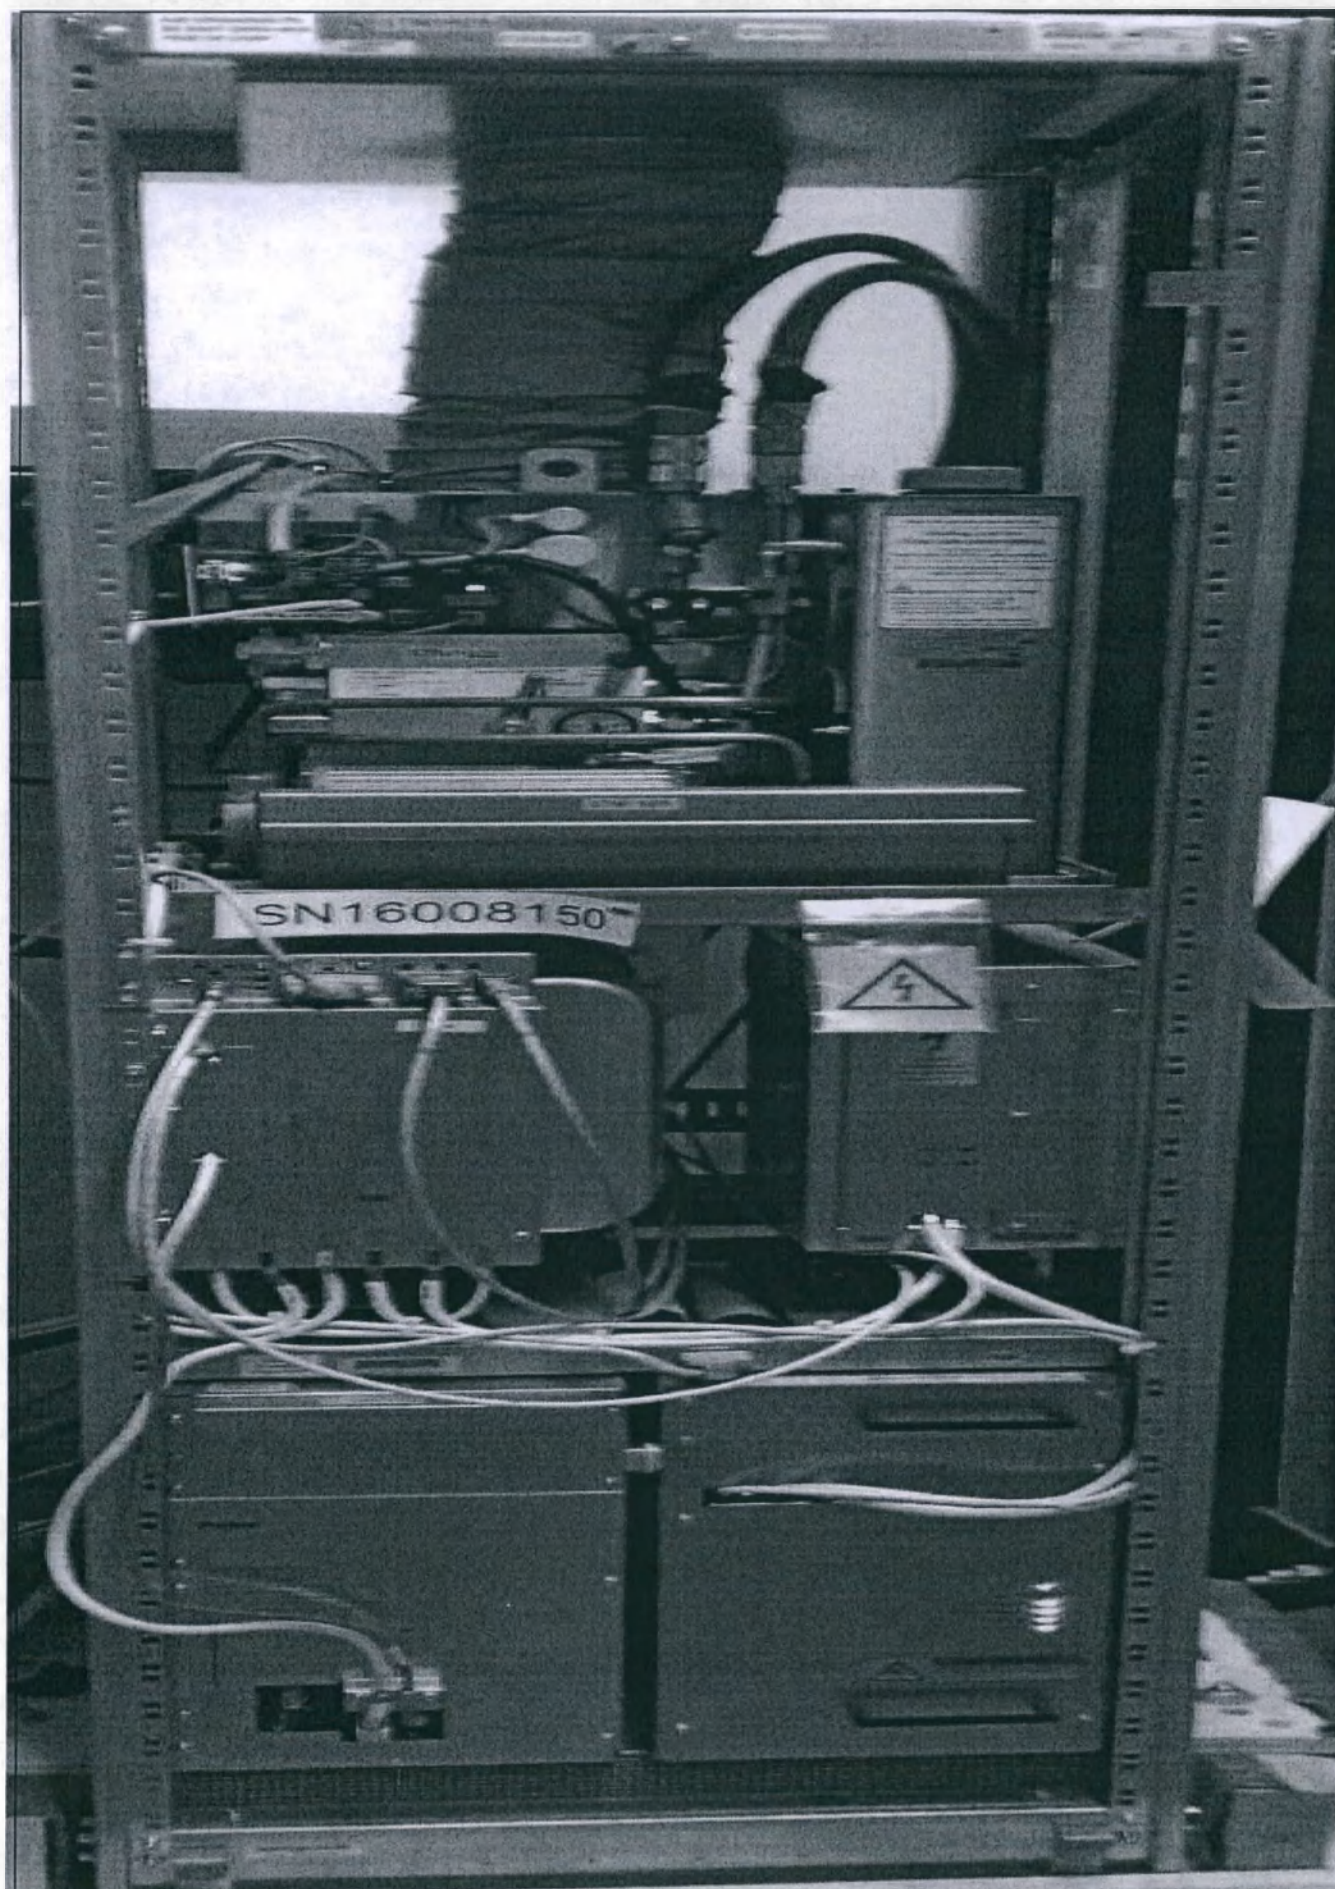


4.6. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

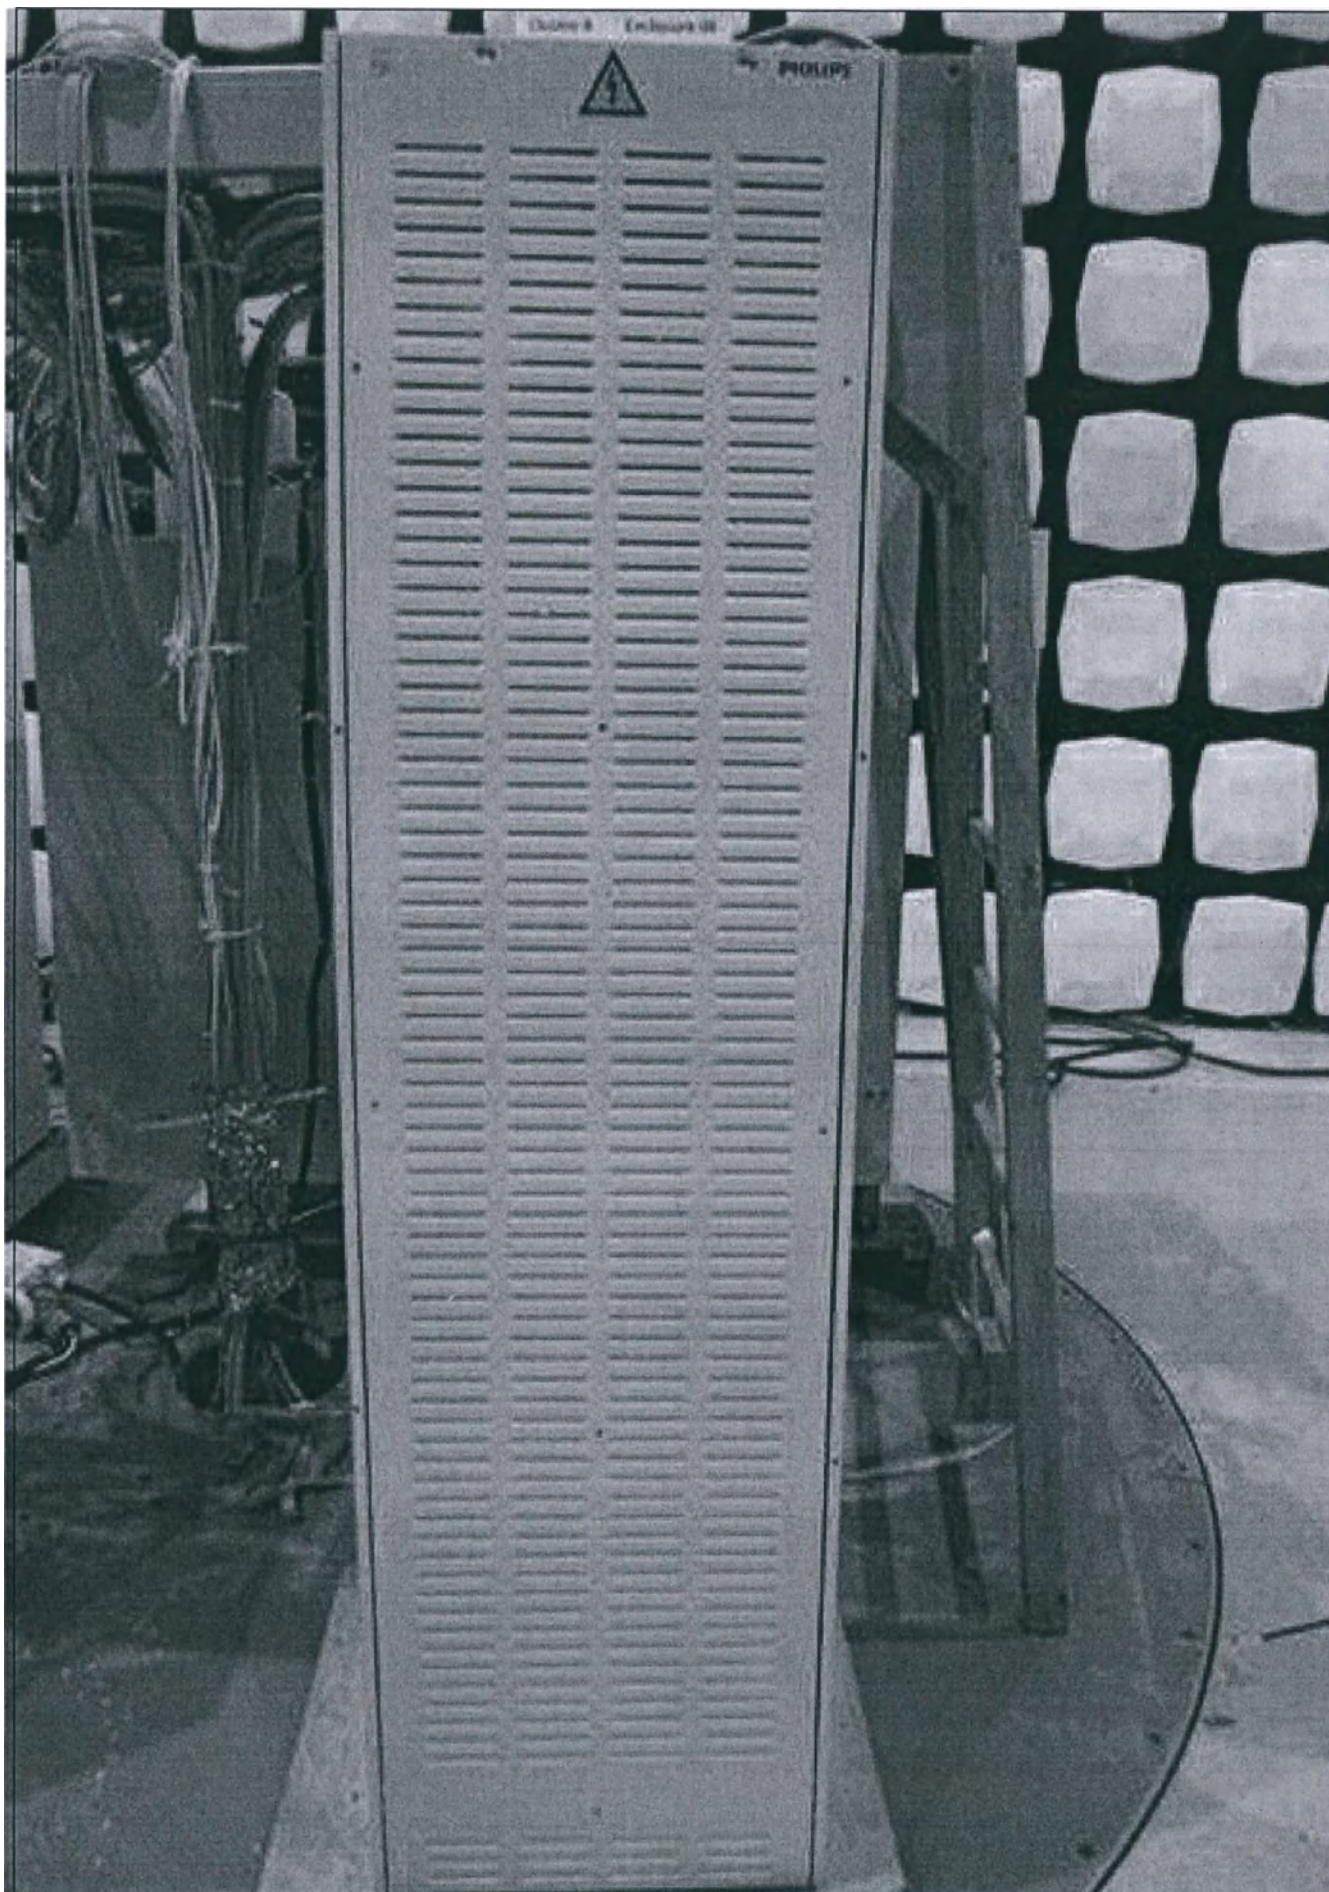


5.а. Шкаф управления.

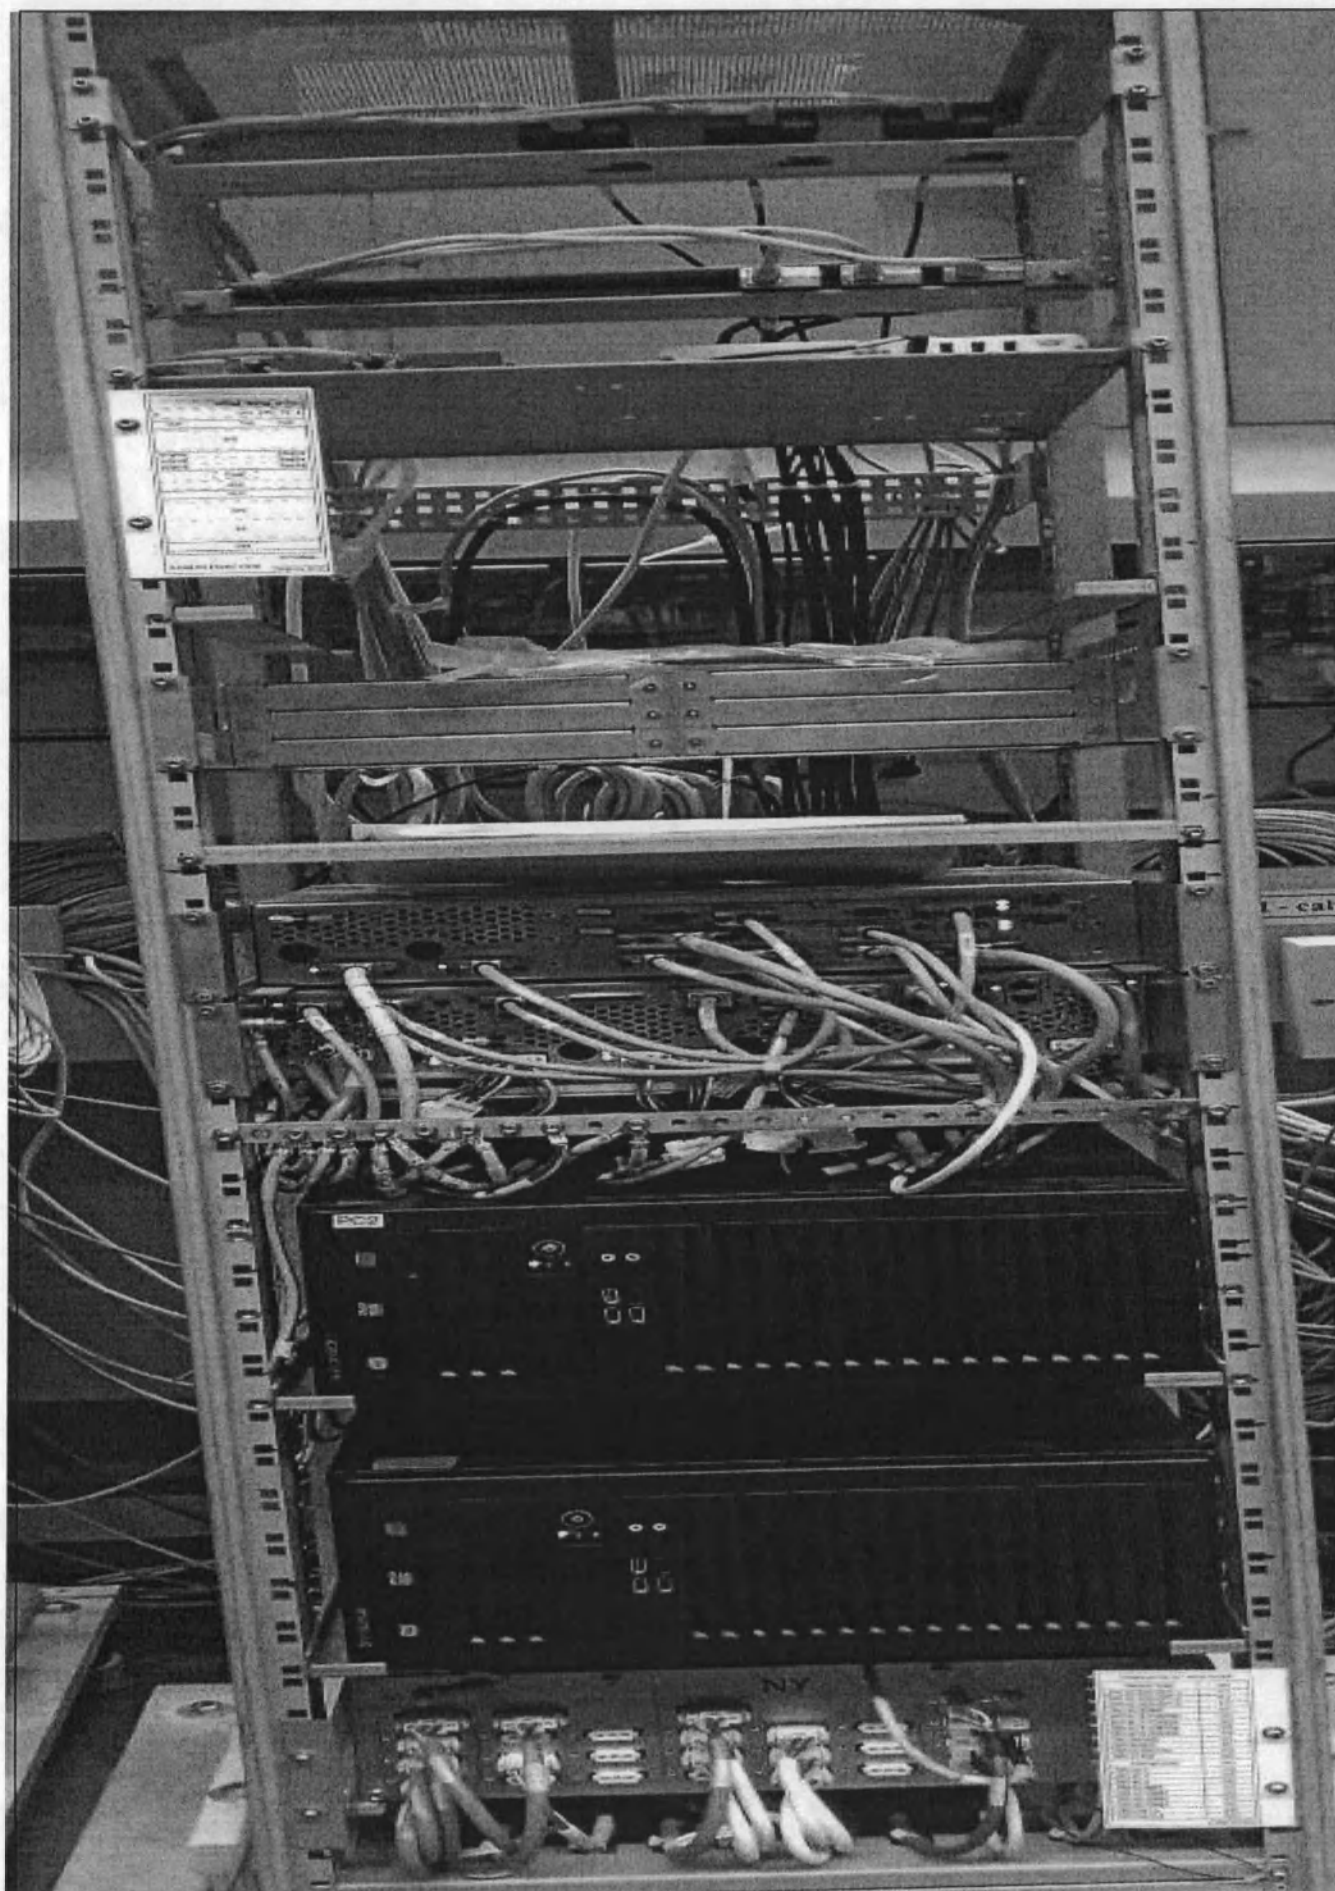


5.6. Шкаф управления.

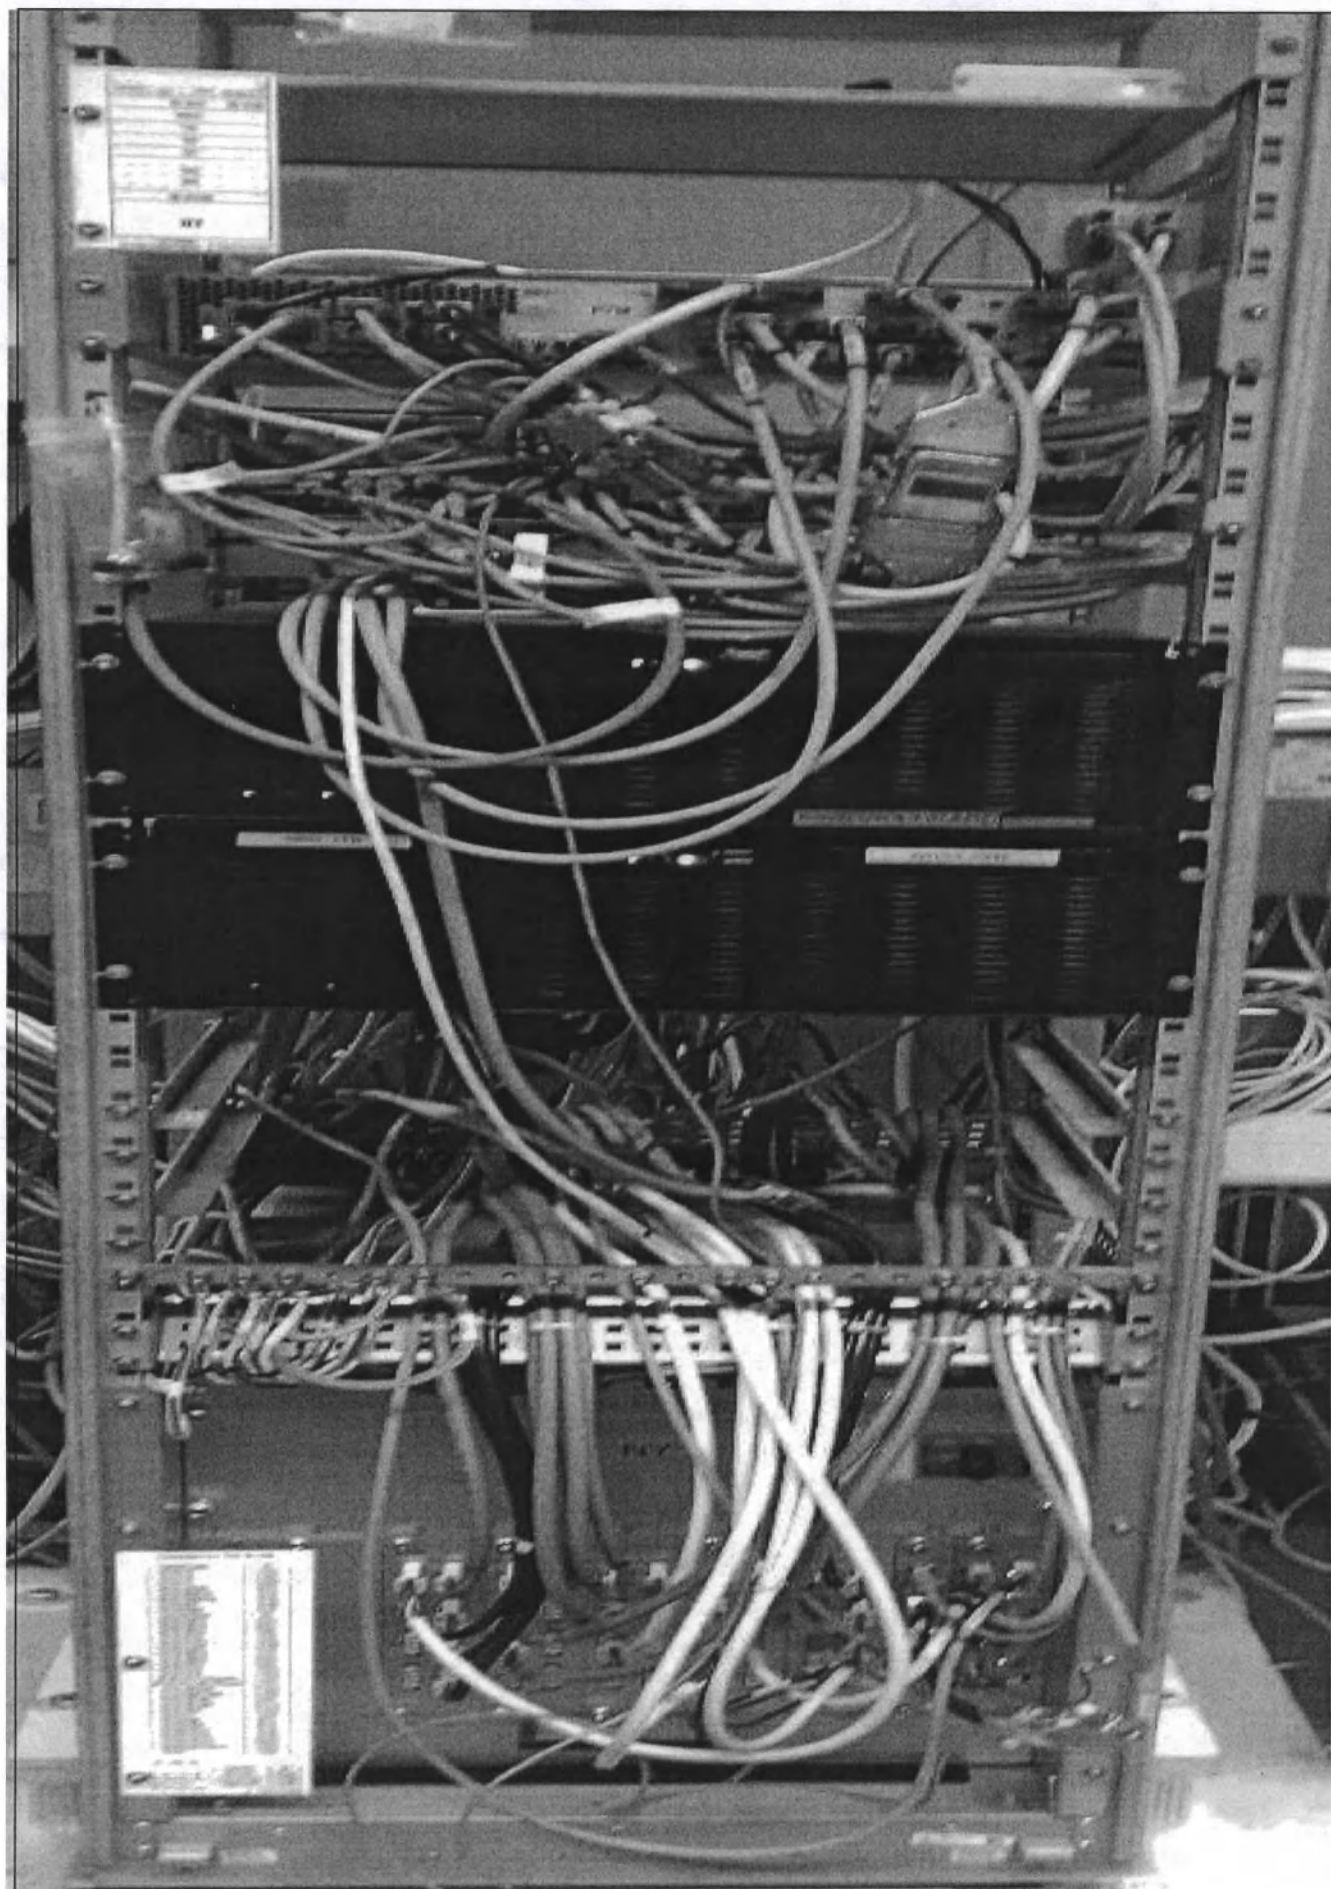

б.а. Распределительный щит.

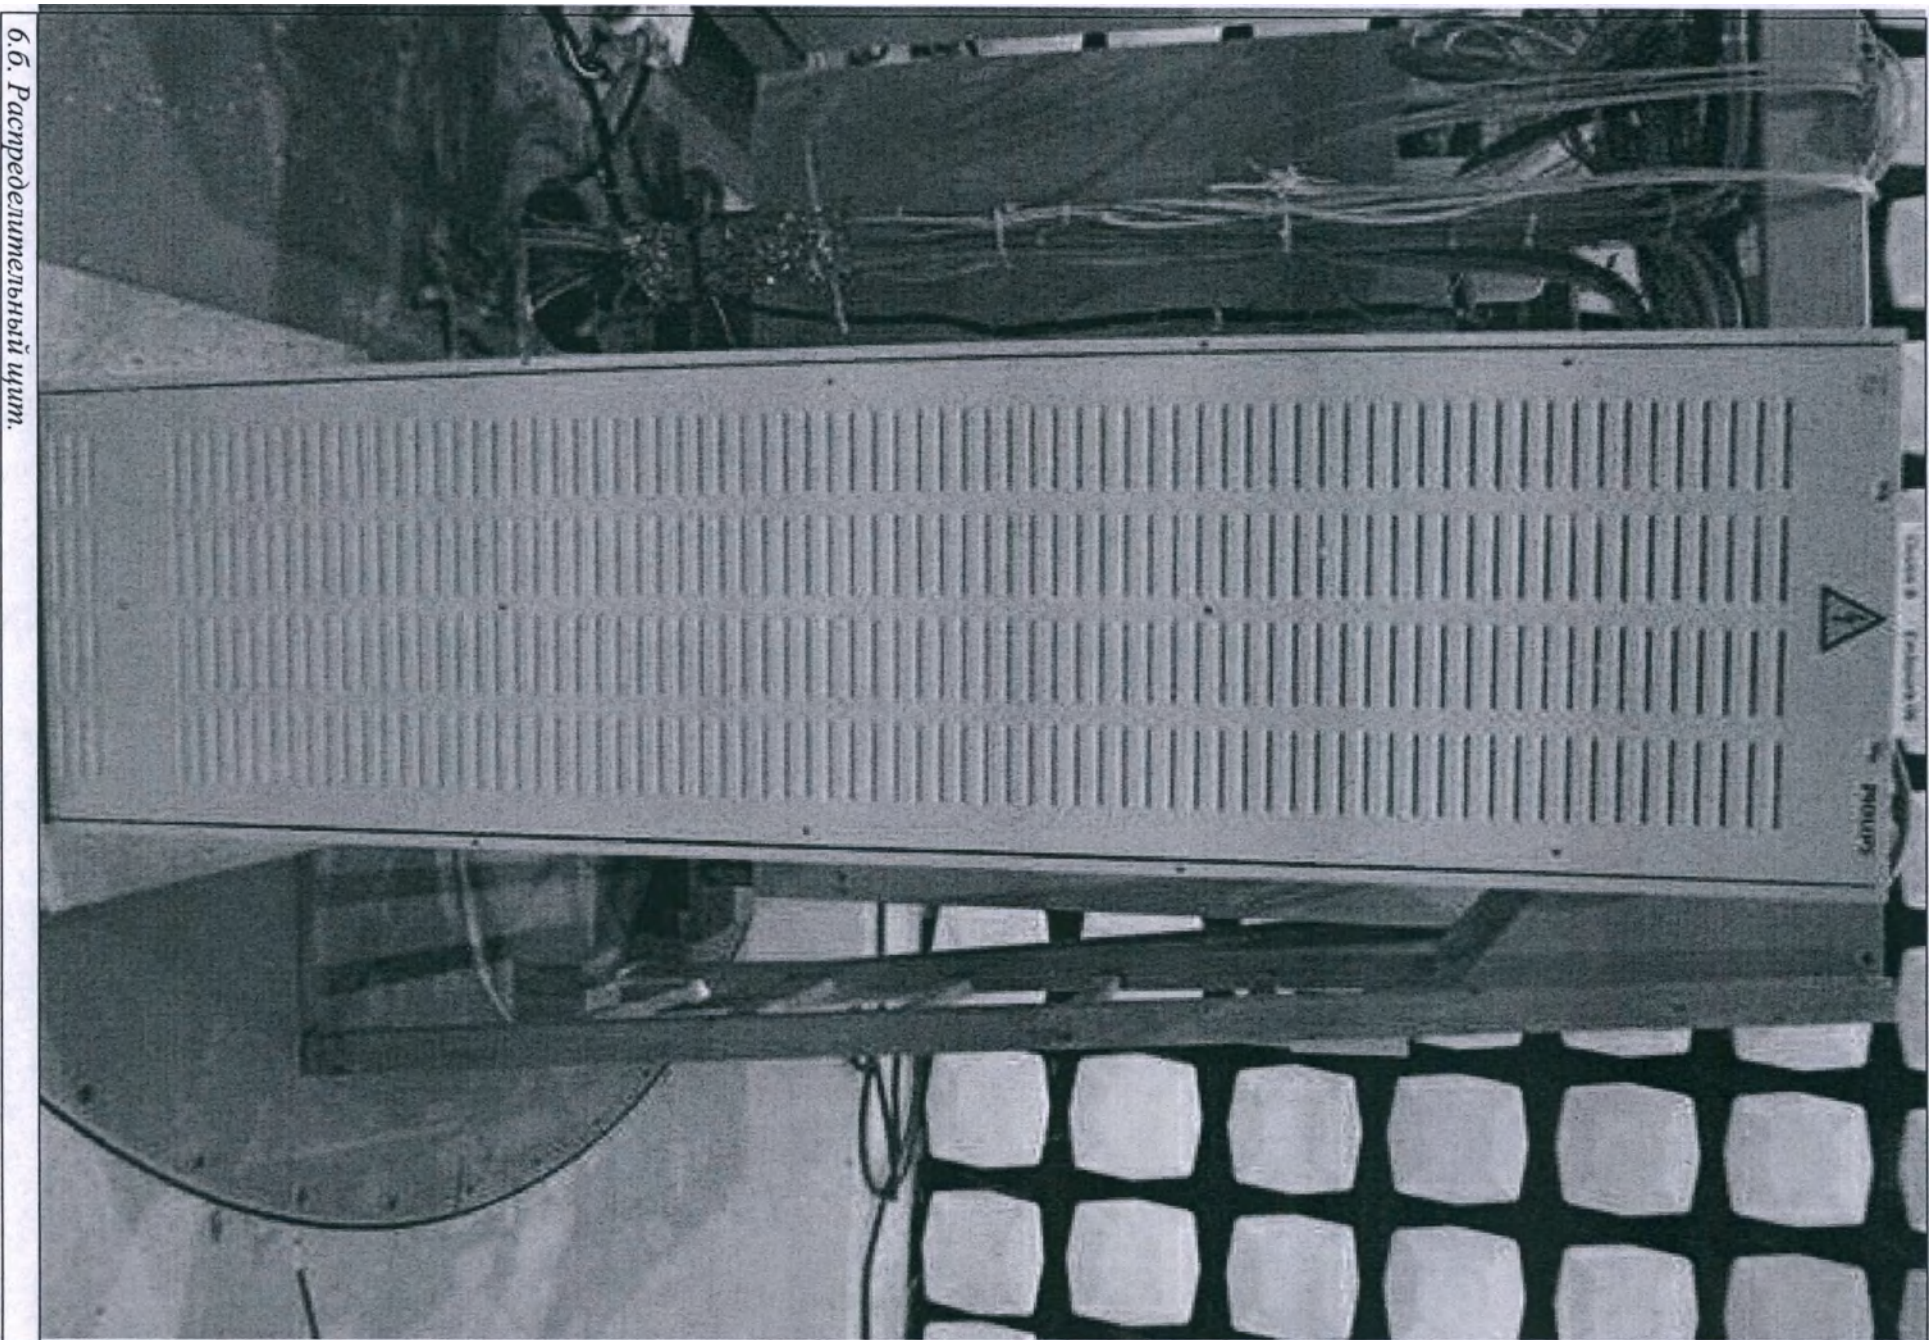


6.6. Распределительный щит.

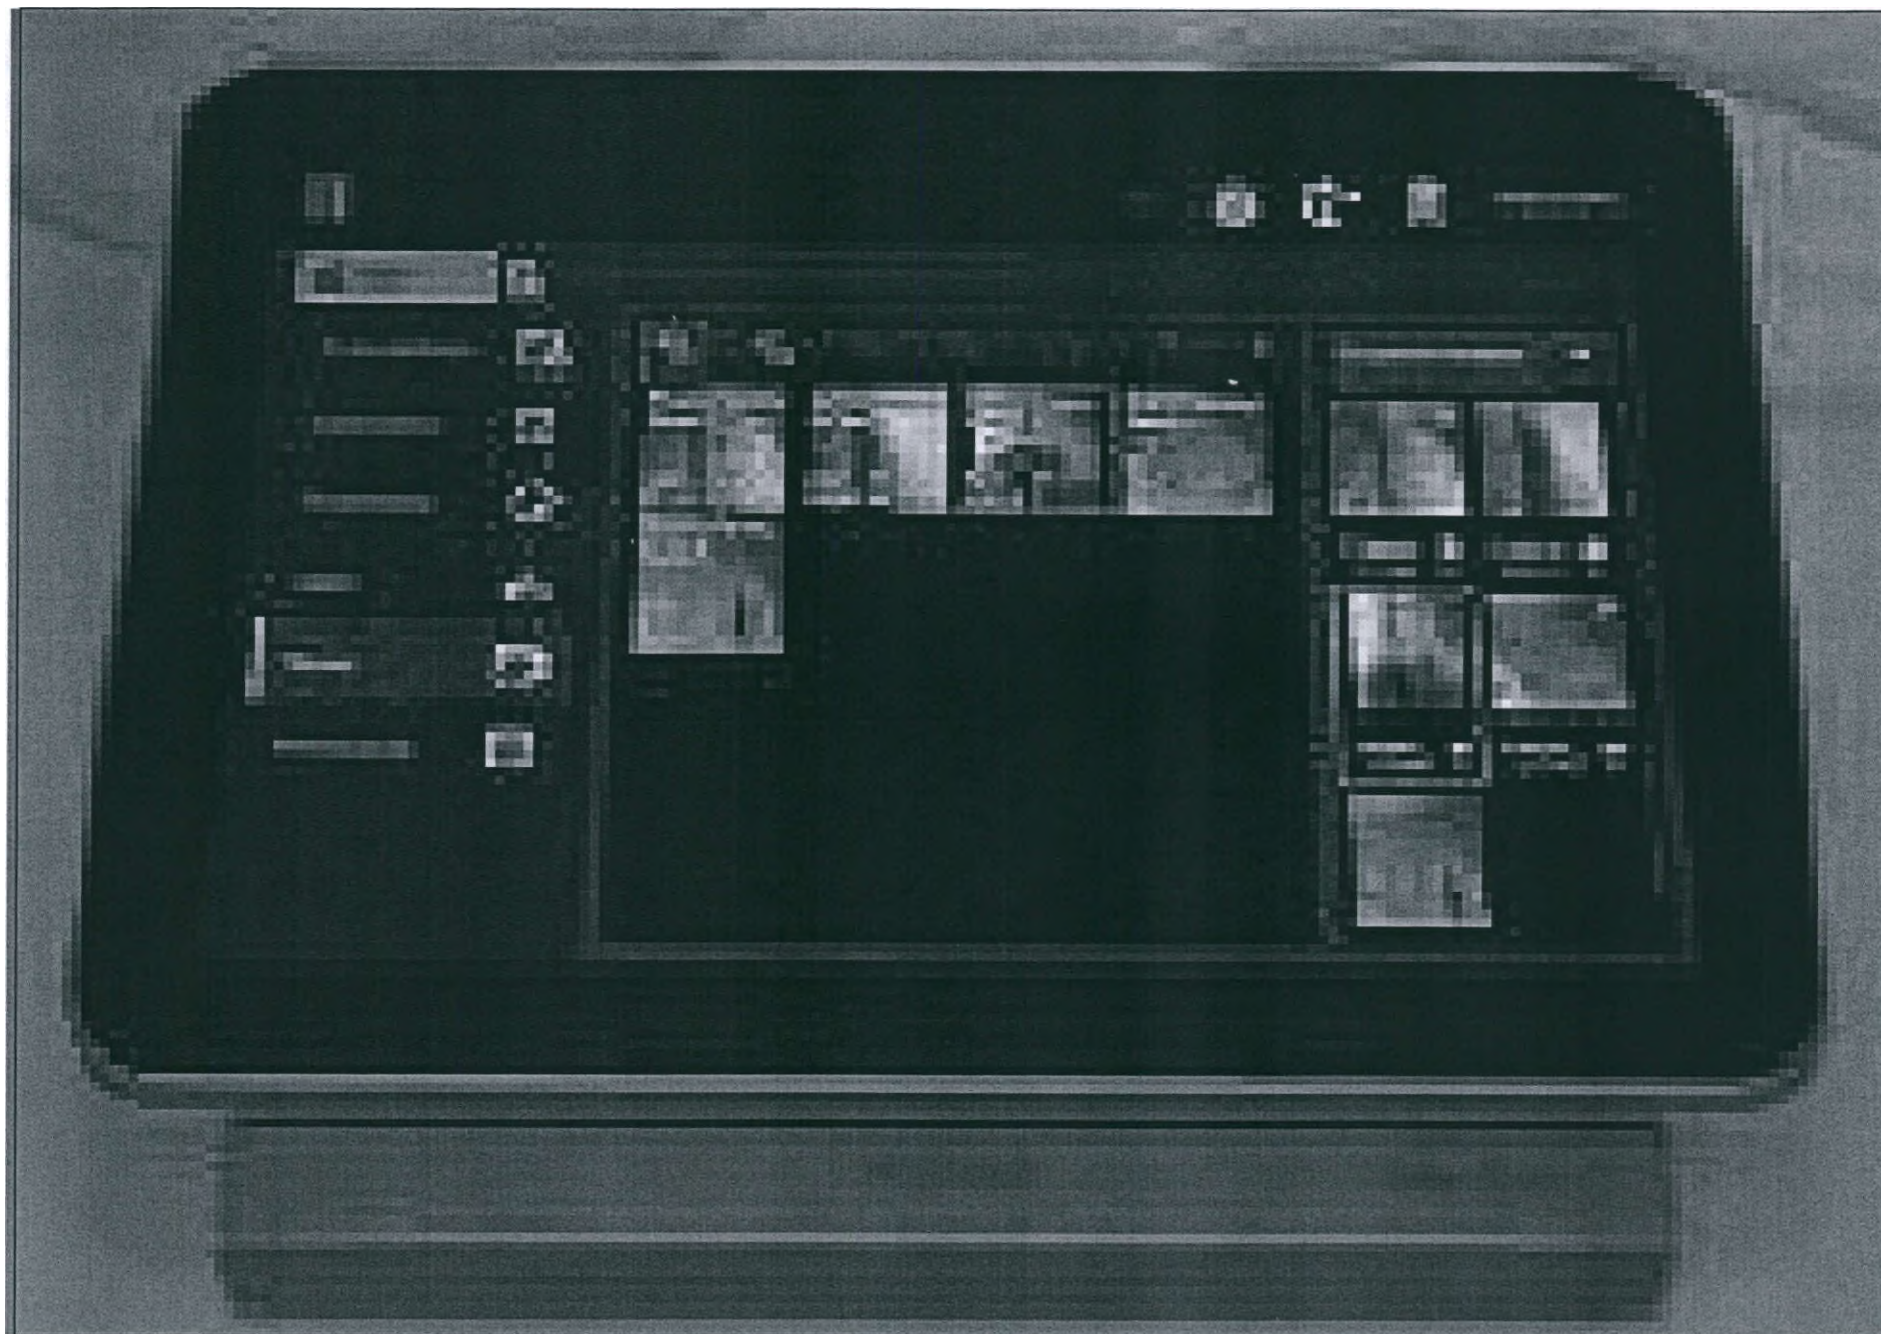


7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.



8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

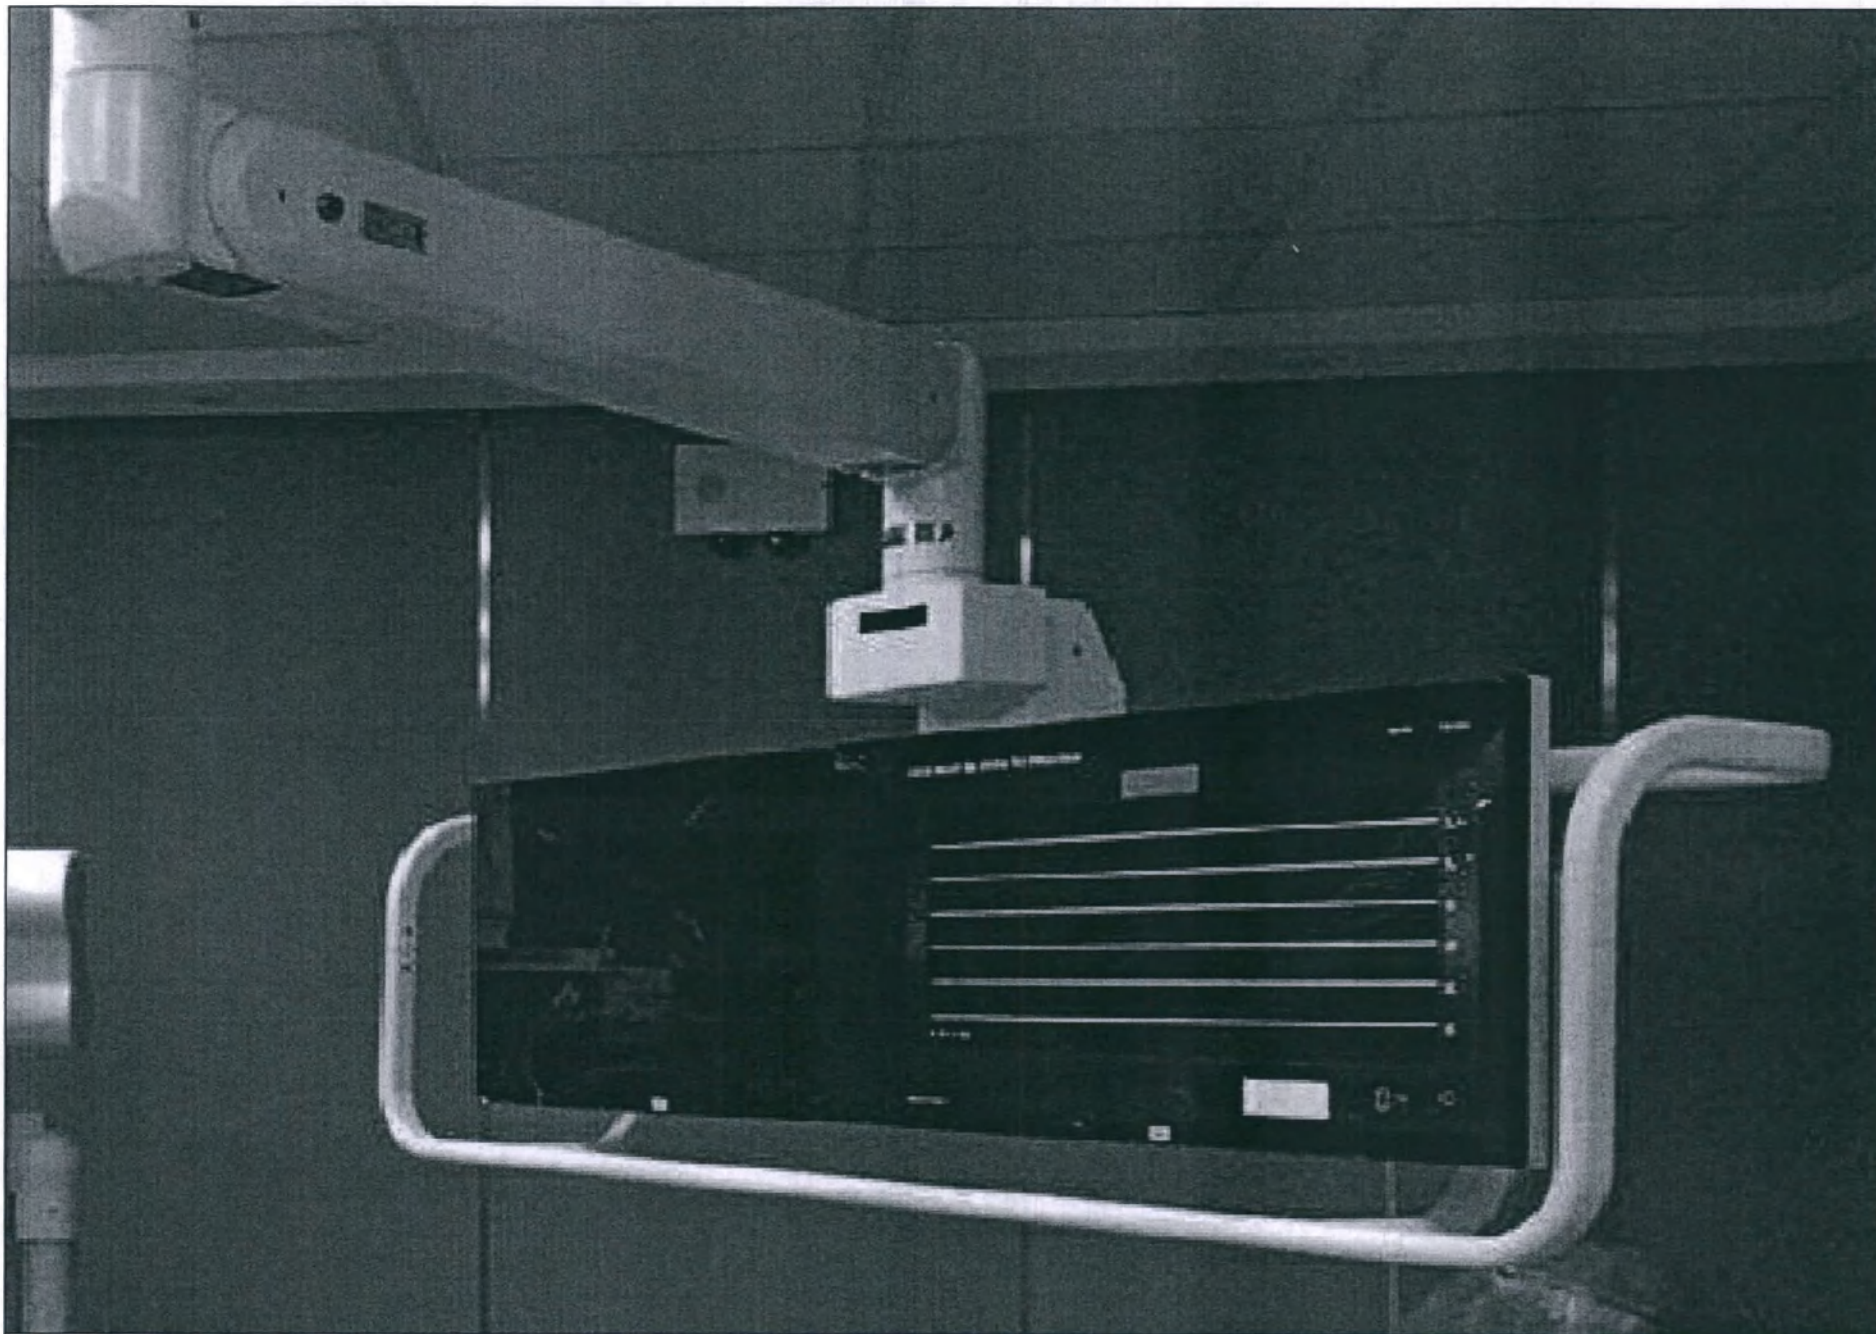


9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

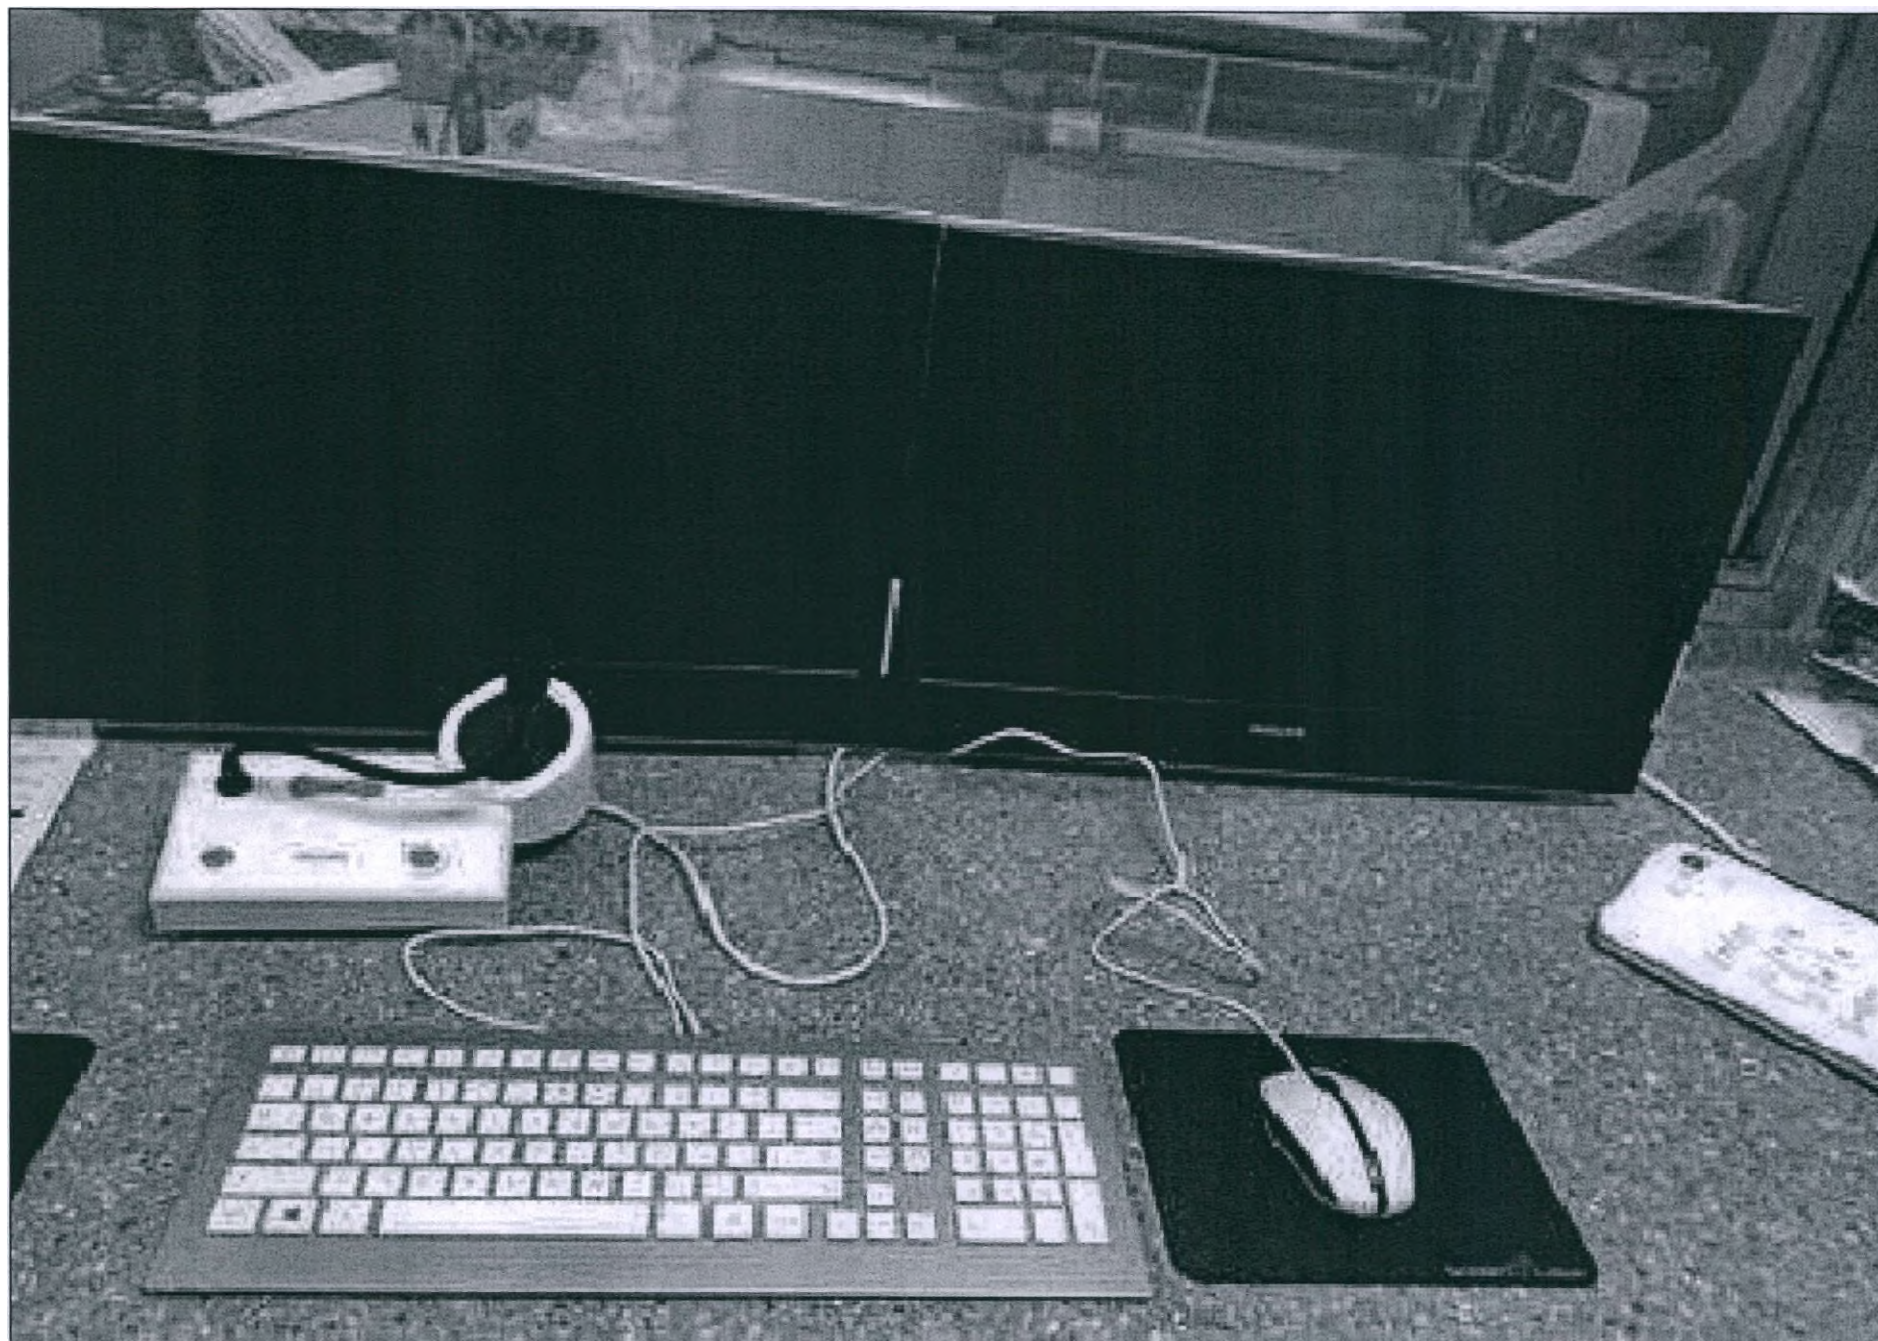

10. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма – 2шт.; Модуль просмотра, не более 3шт.; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.




10.а. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма-2шт.; Модуль просмотра, не более 3шт.; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

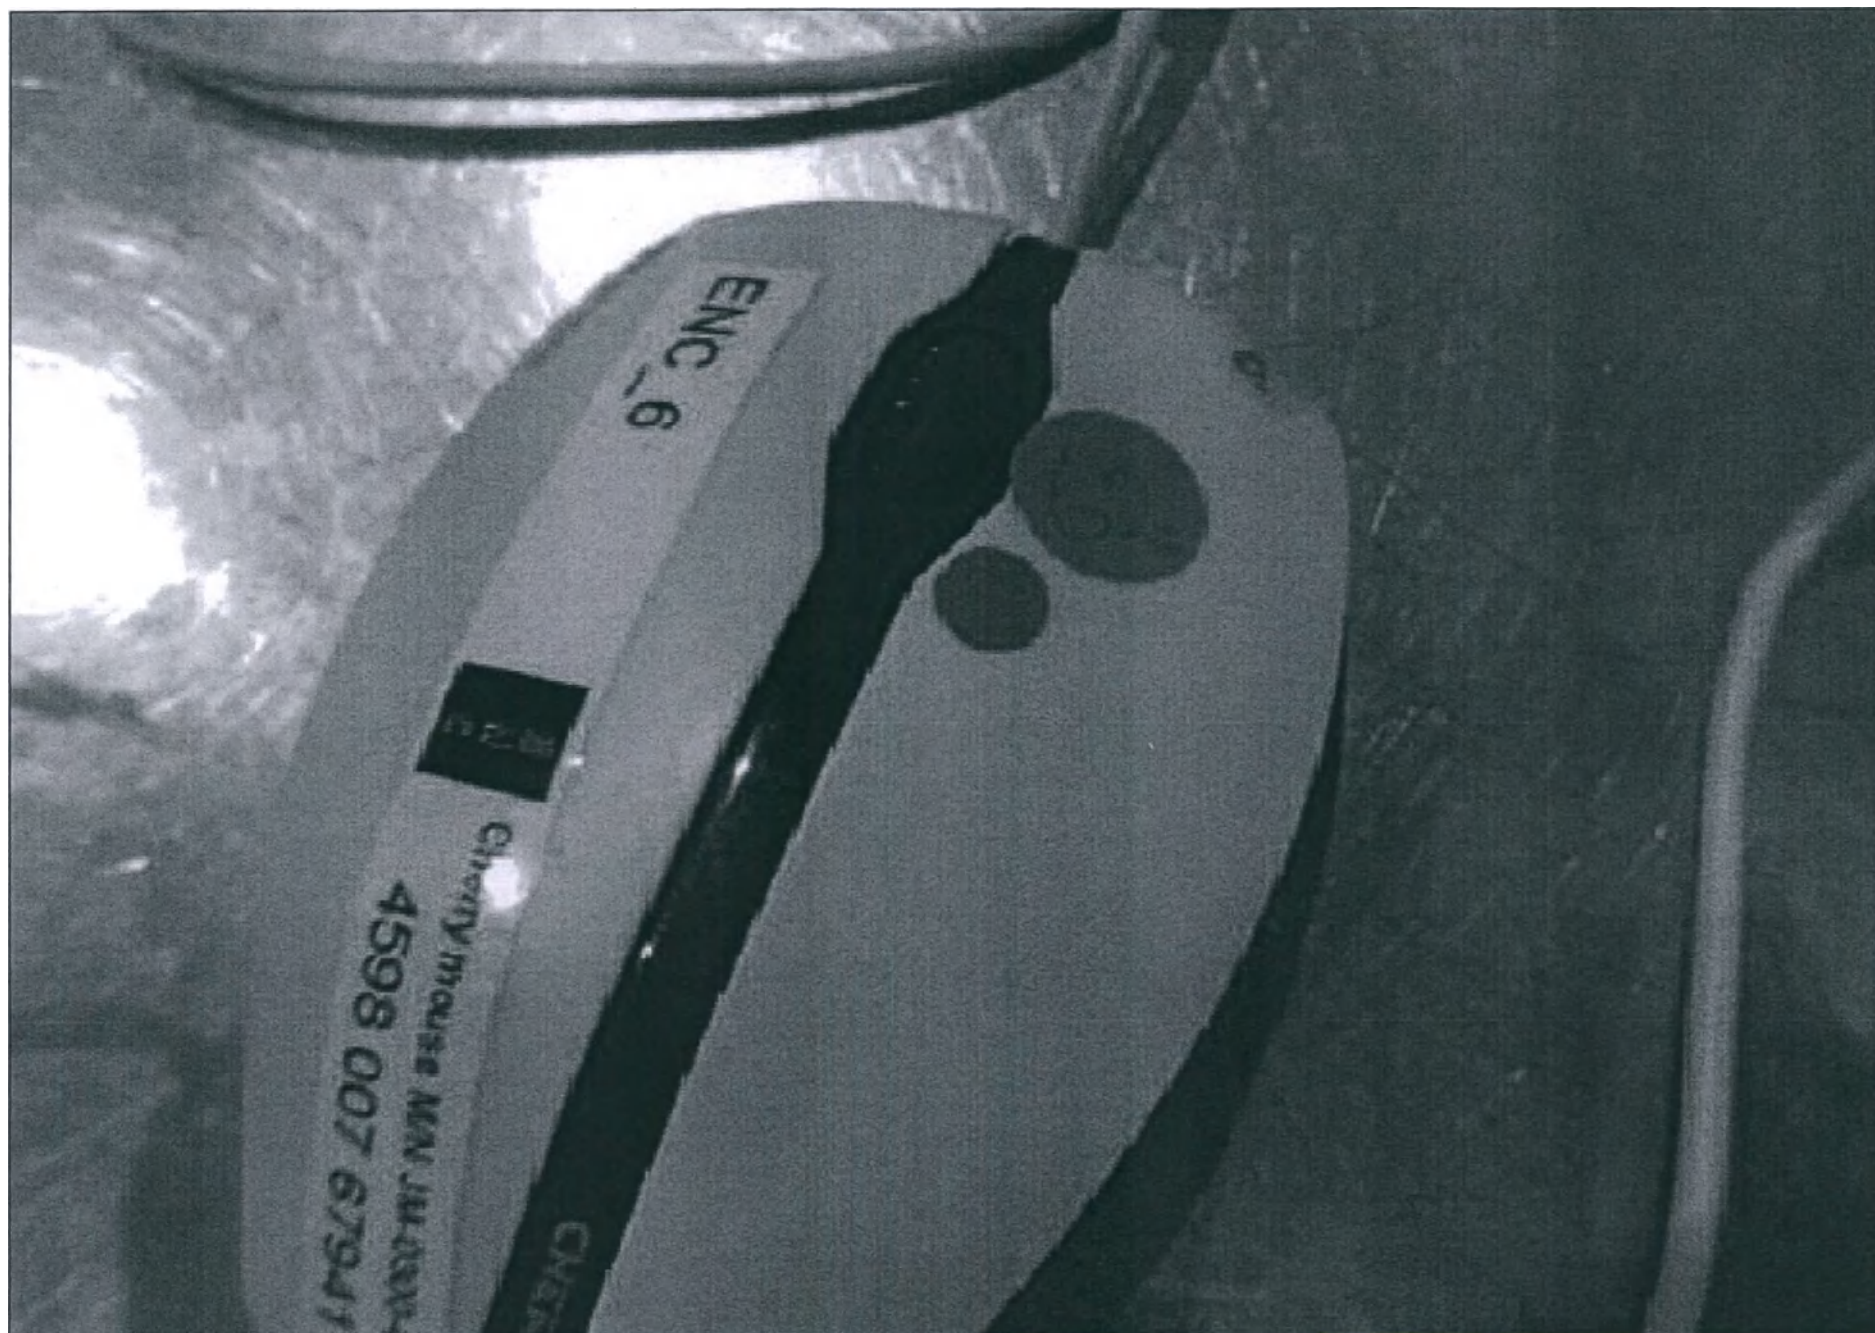


10.в. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма-2шт.; Модуль просмотра, не более 3шт.; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.




10.2. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма-2шт.; Модуль просмотра, не более 3шт.; **Мышь**; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

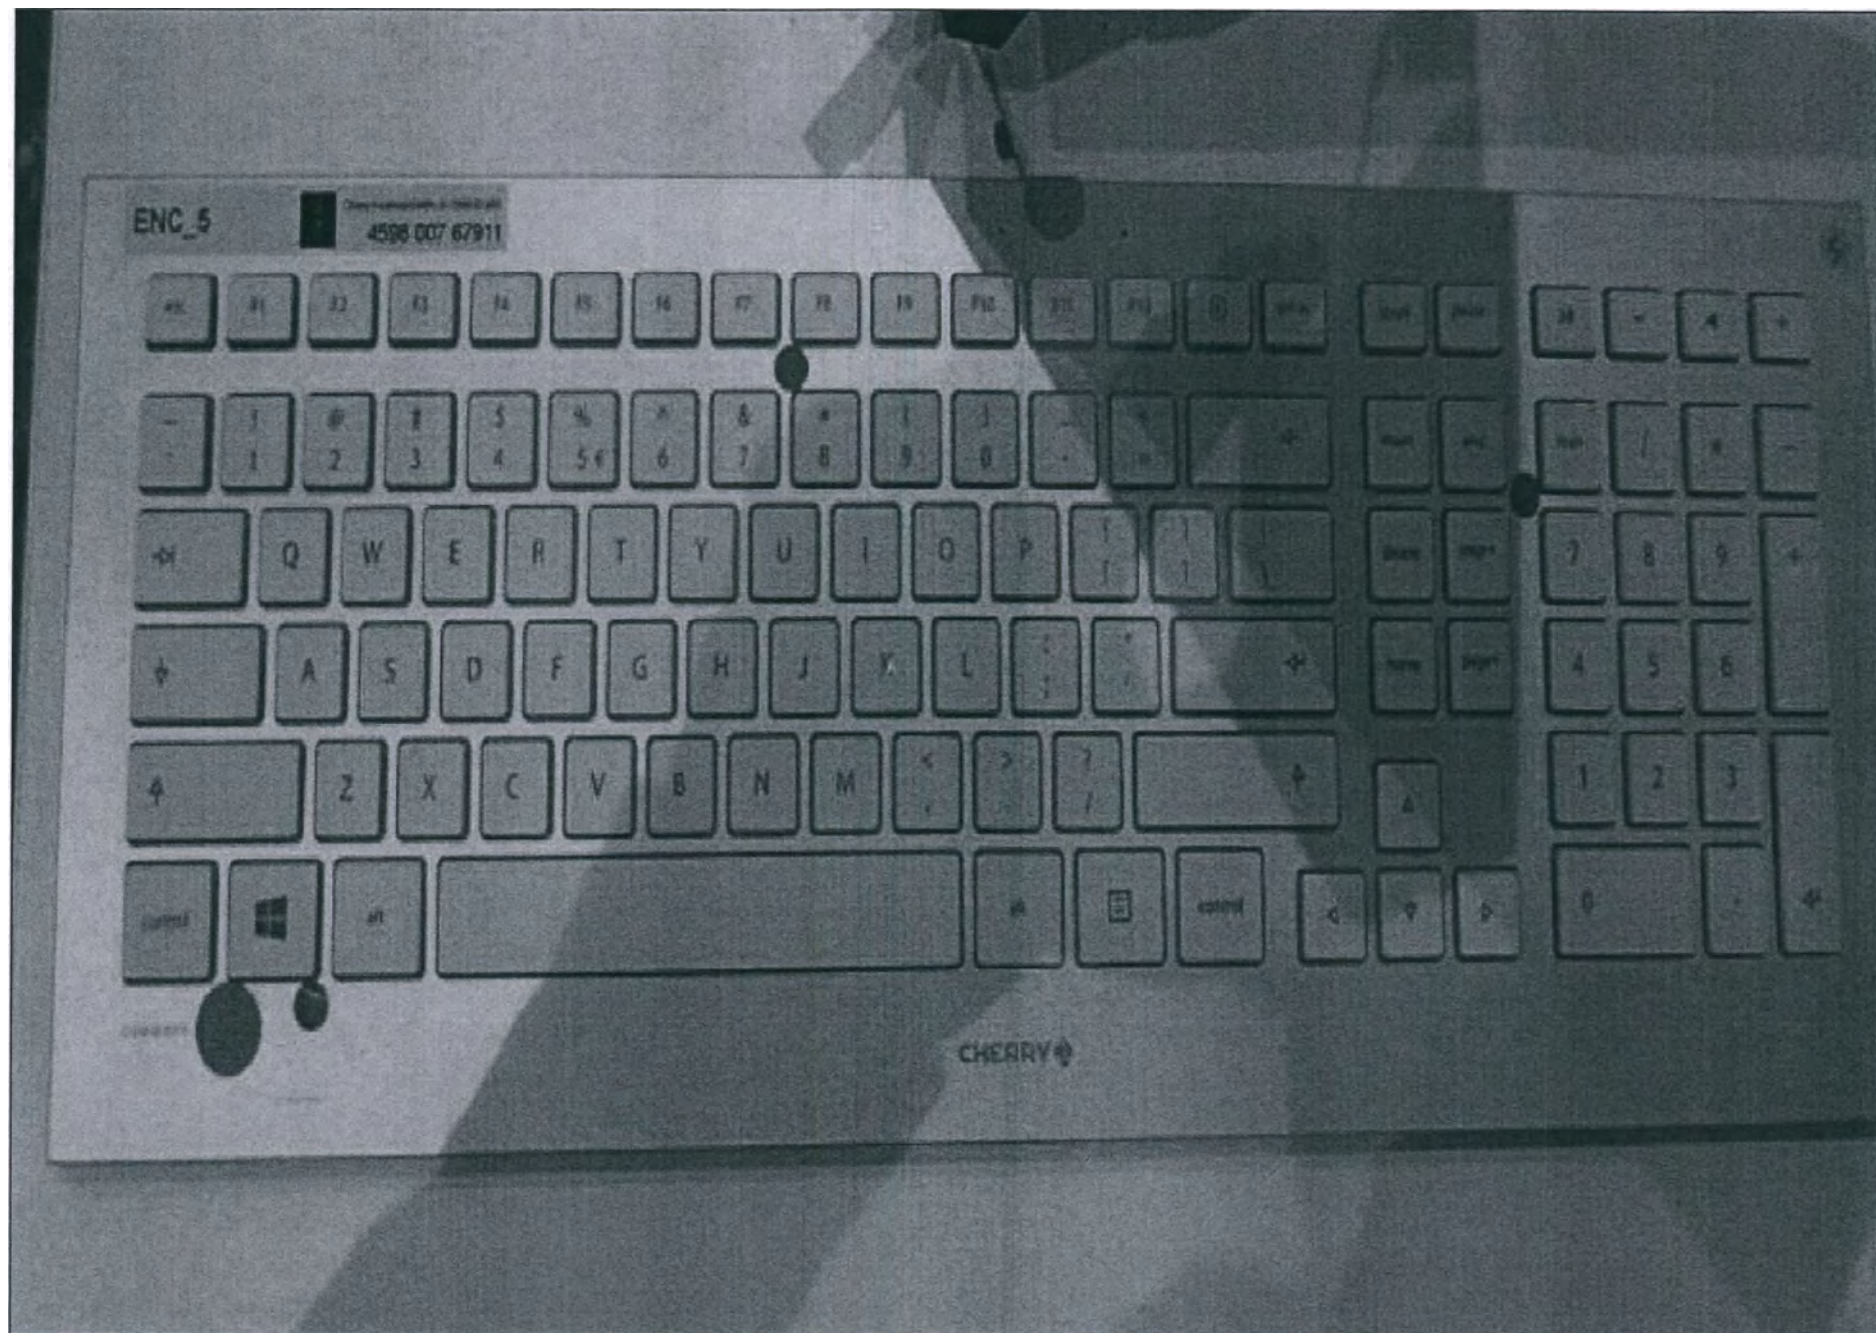


10.д. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма-2шт.; Модуль просмотра, не более 3шт.; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

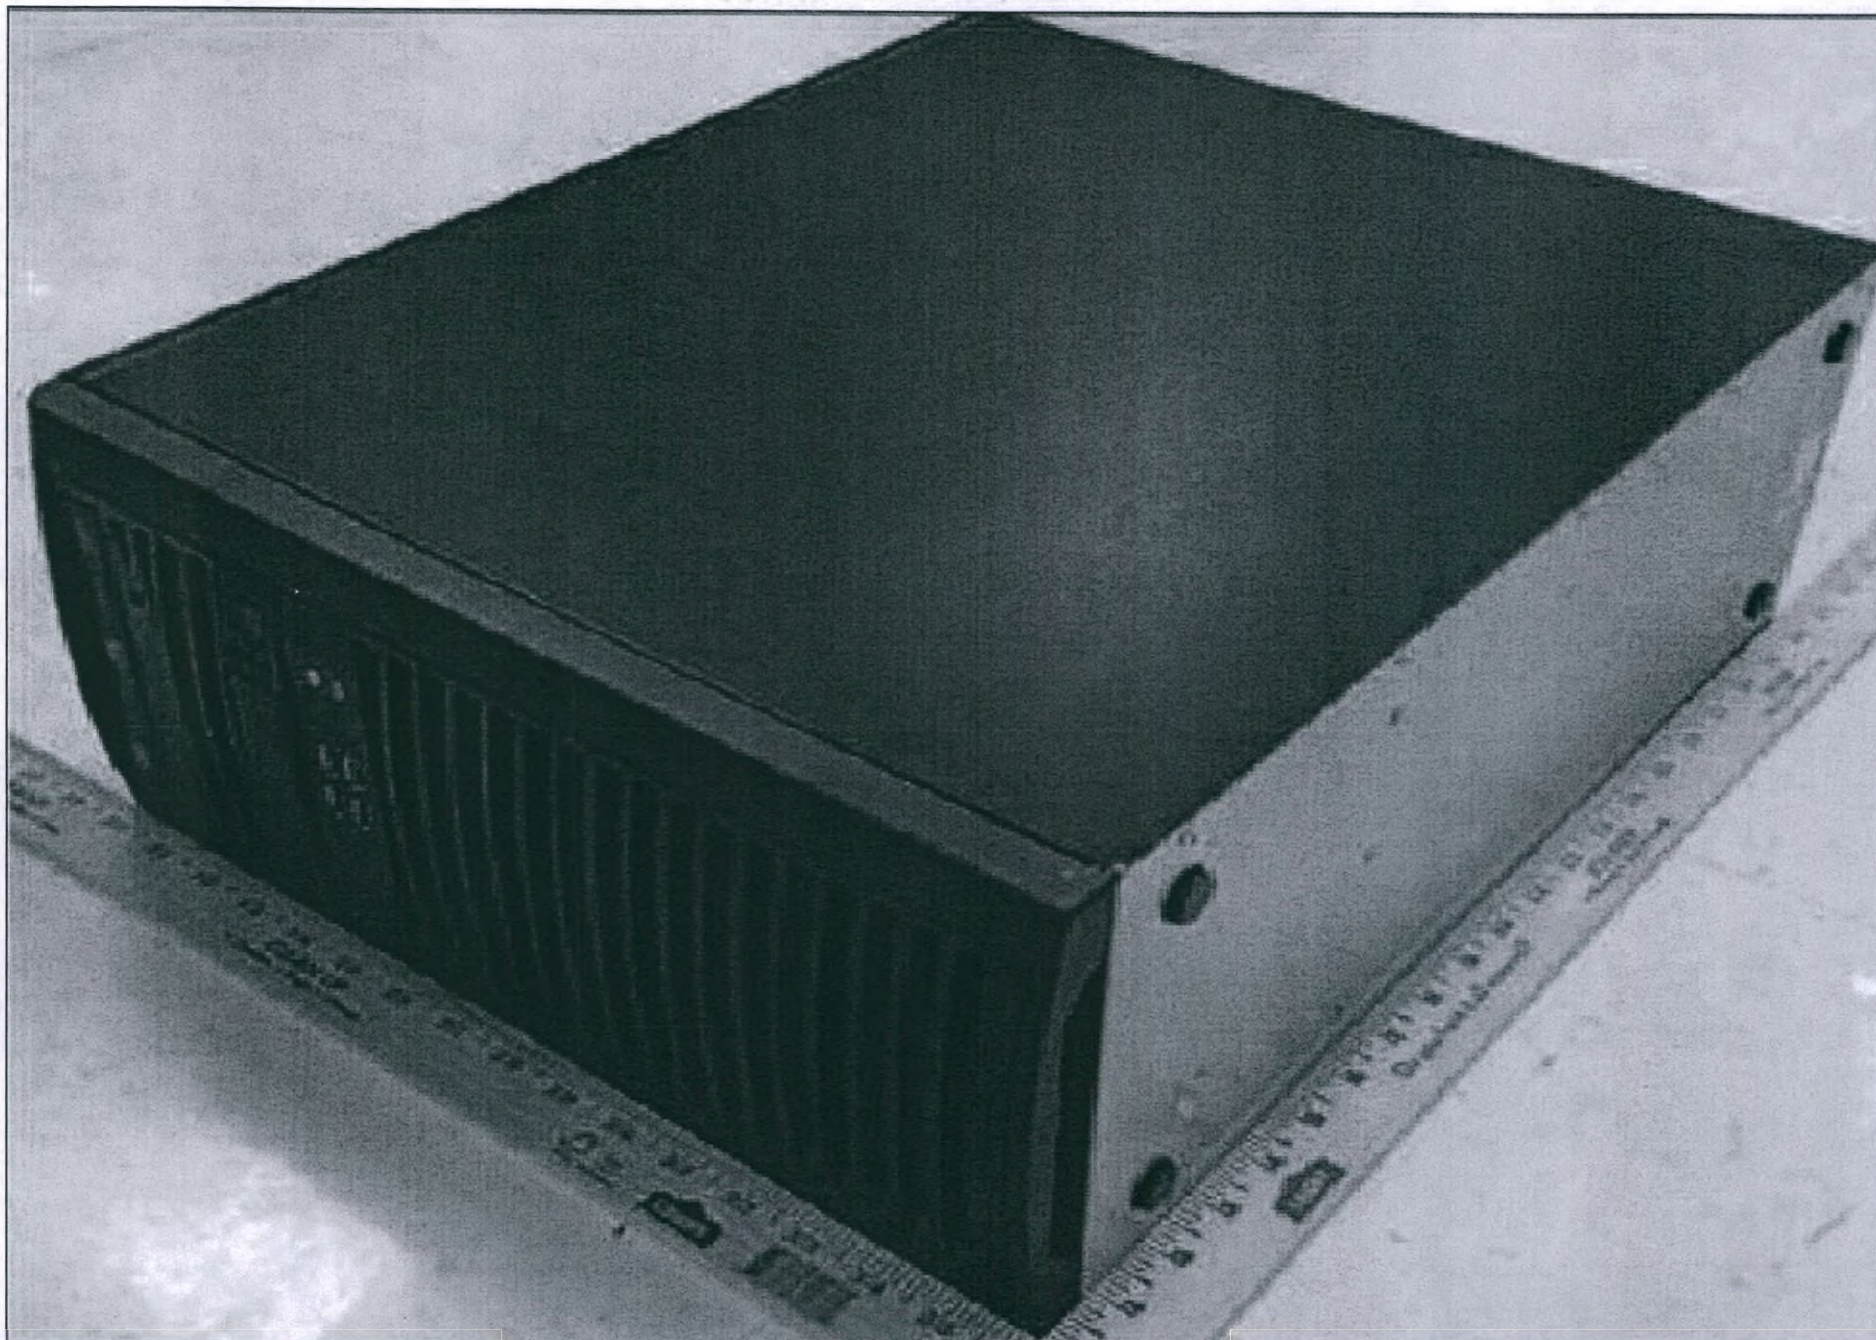

10.е. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма-2шт.; Модуль просмотра, не более 3шт.; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

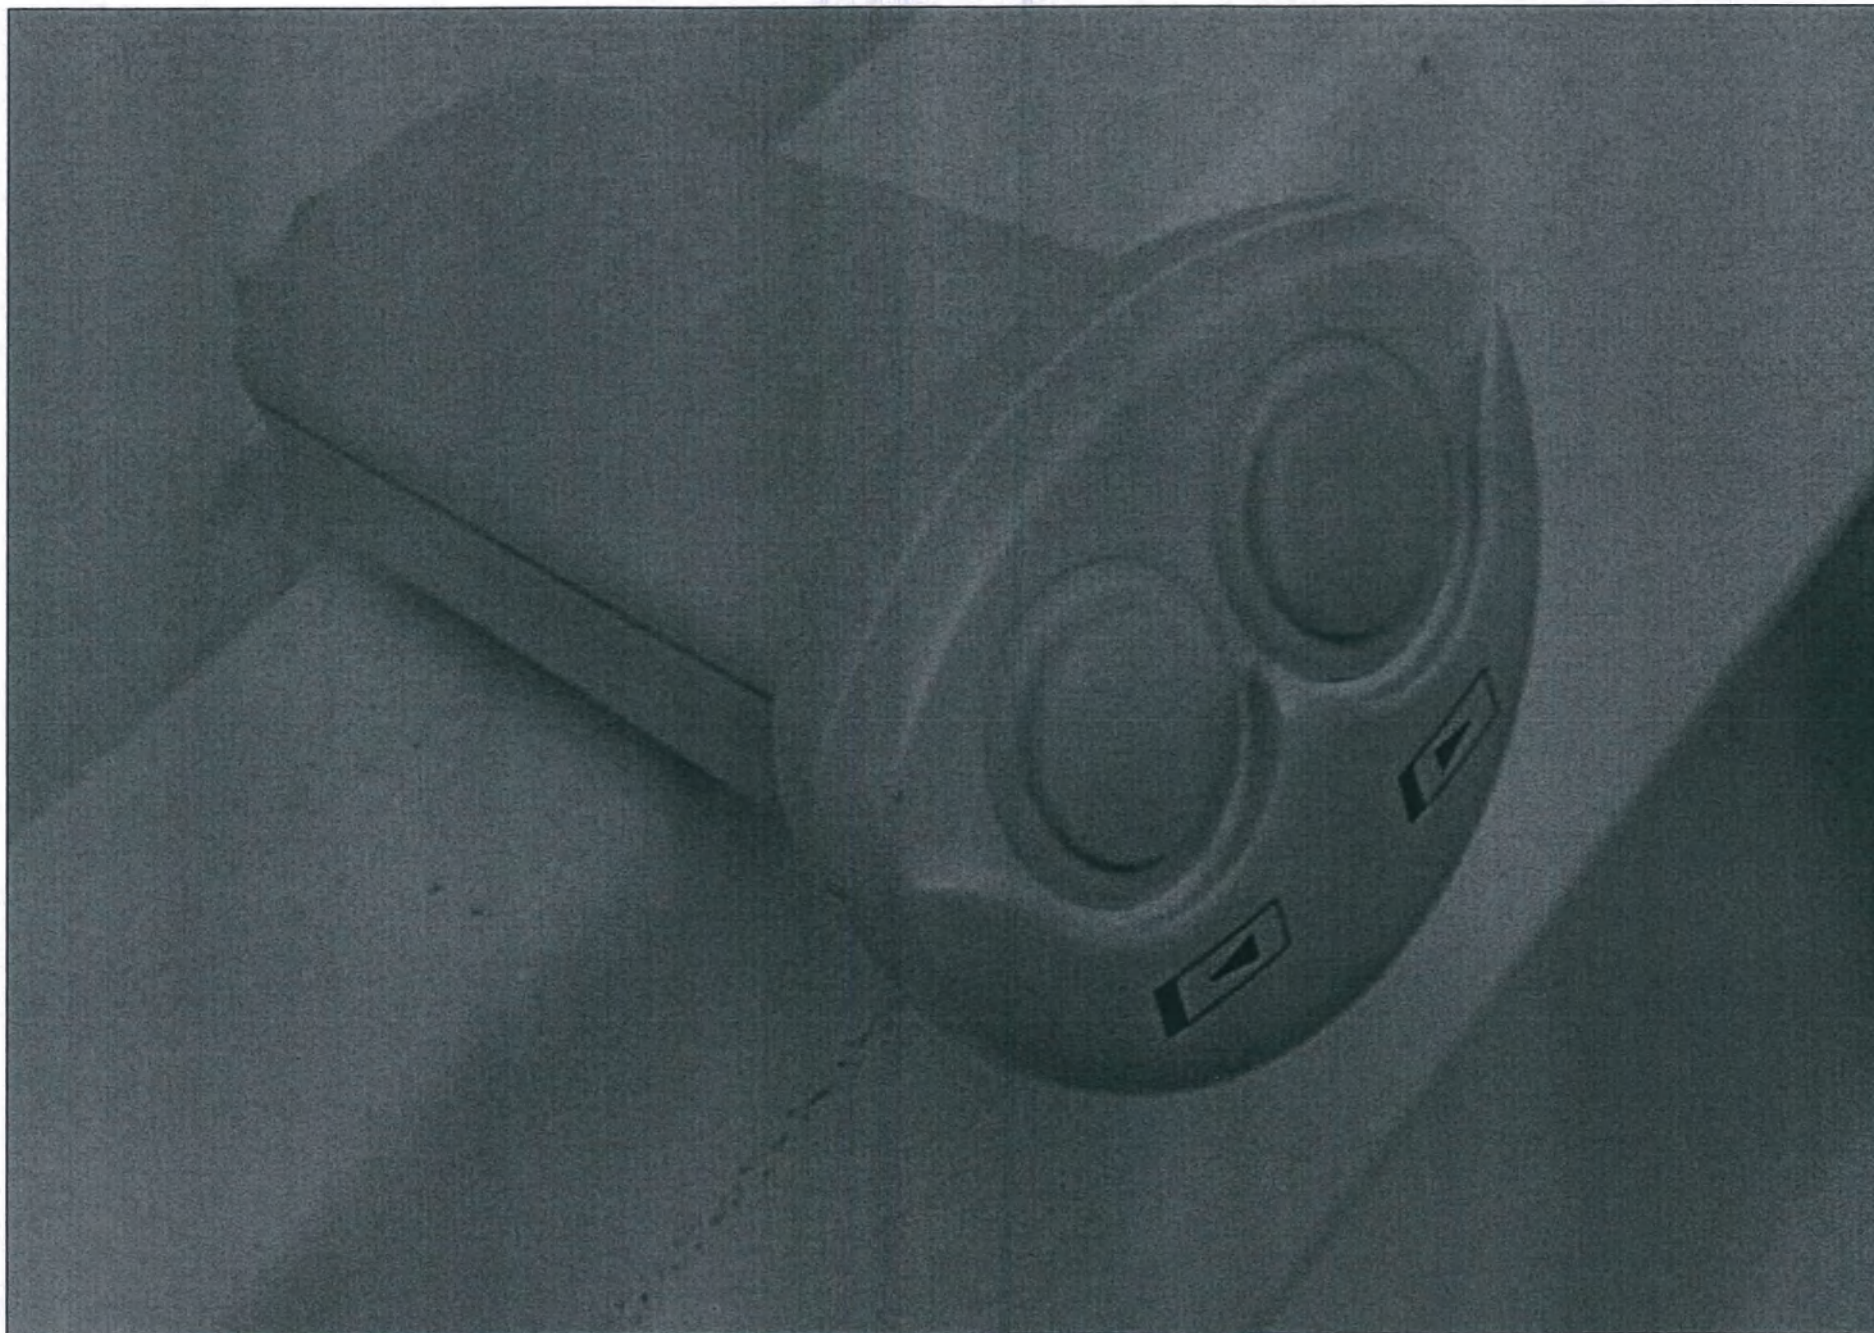


11. Ручной переключатель сдвига.

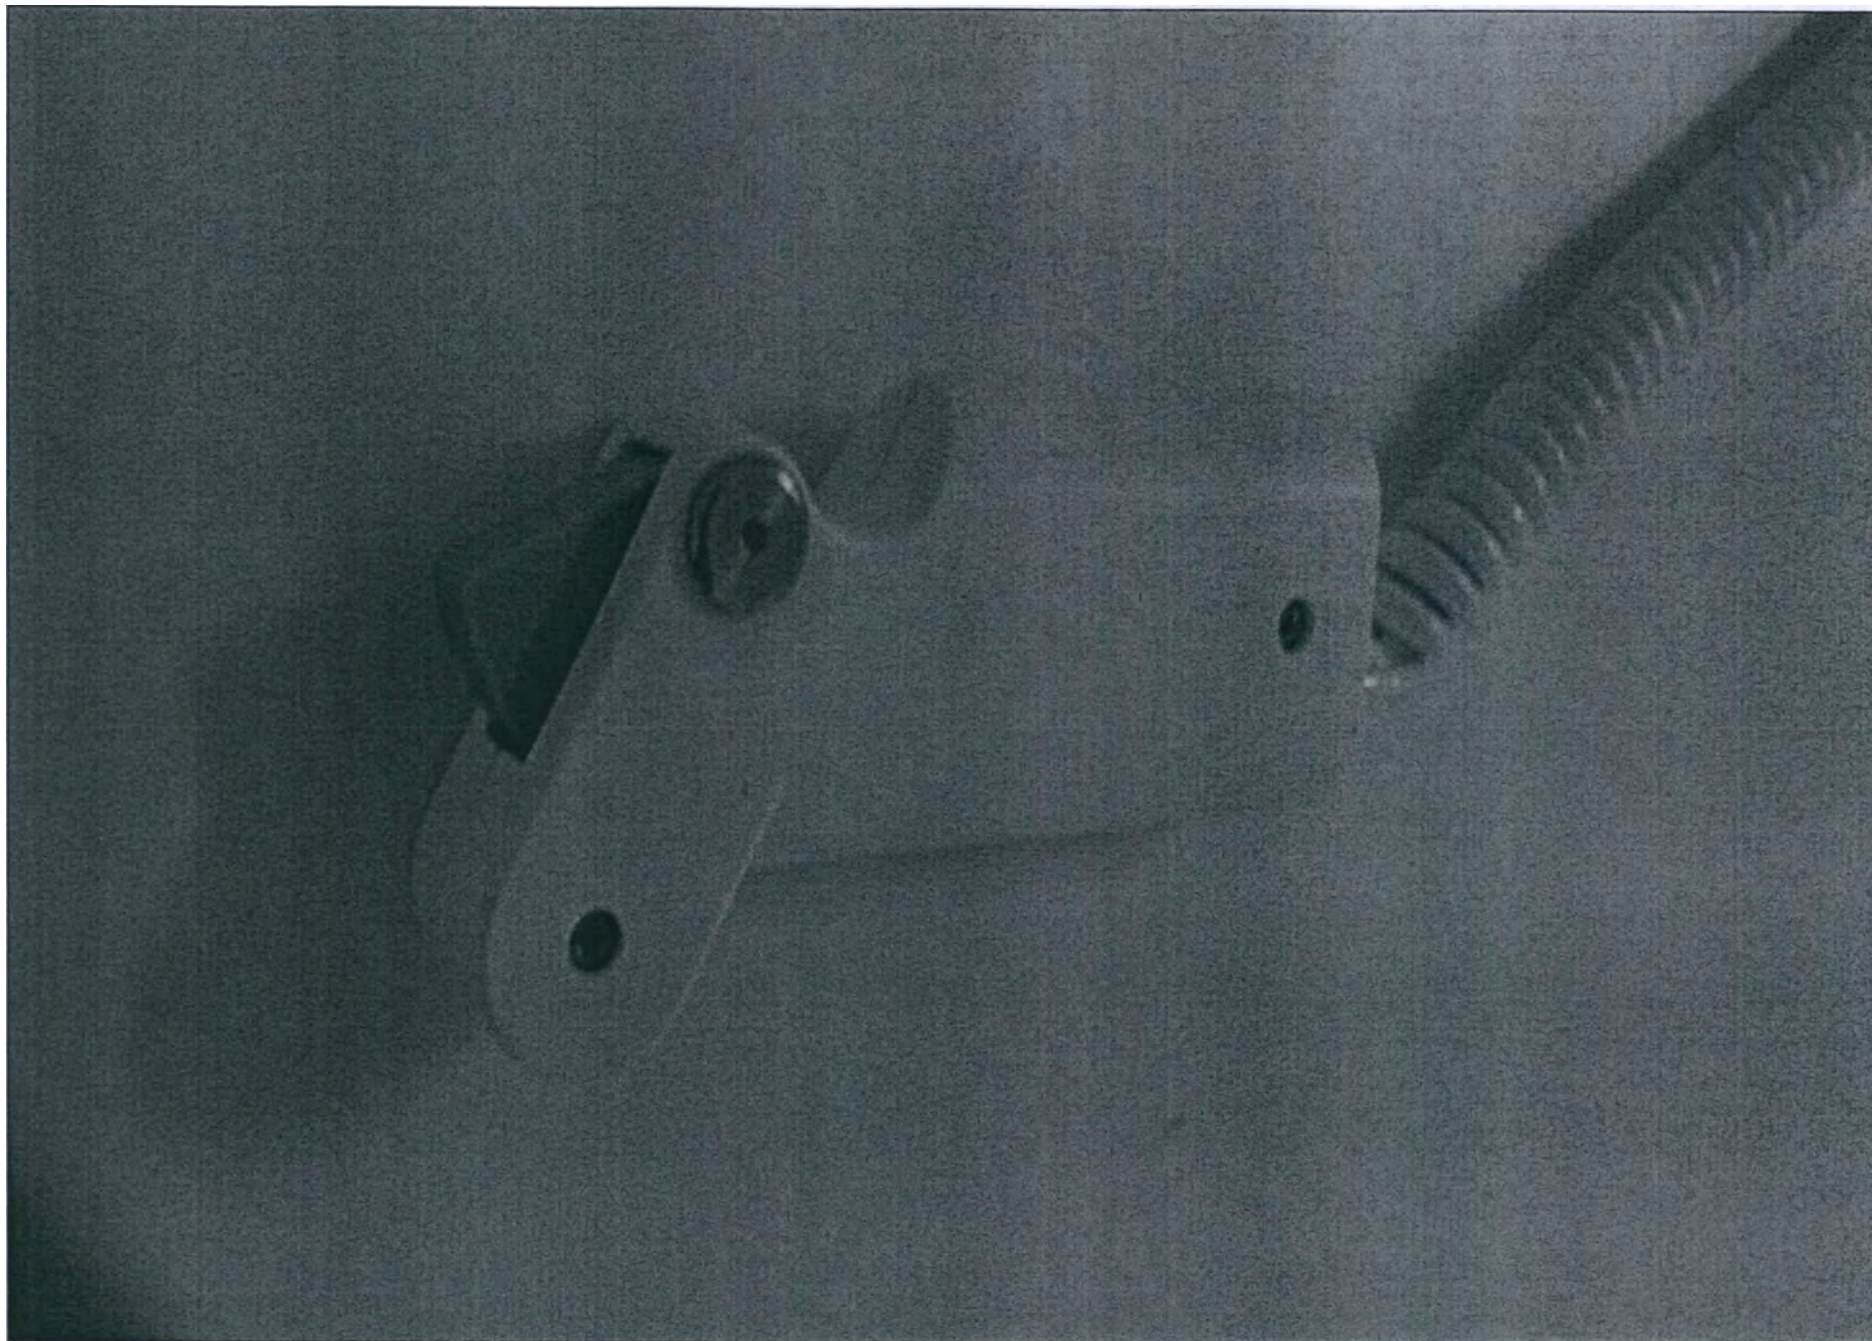


12. Регулятор скорости.




13. Ручной переключатель экспозиции.

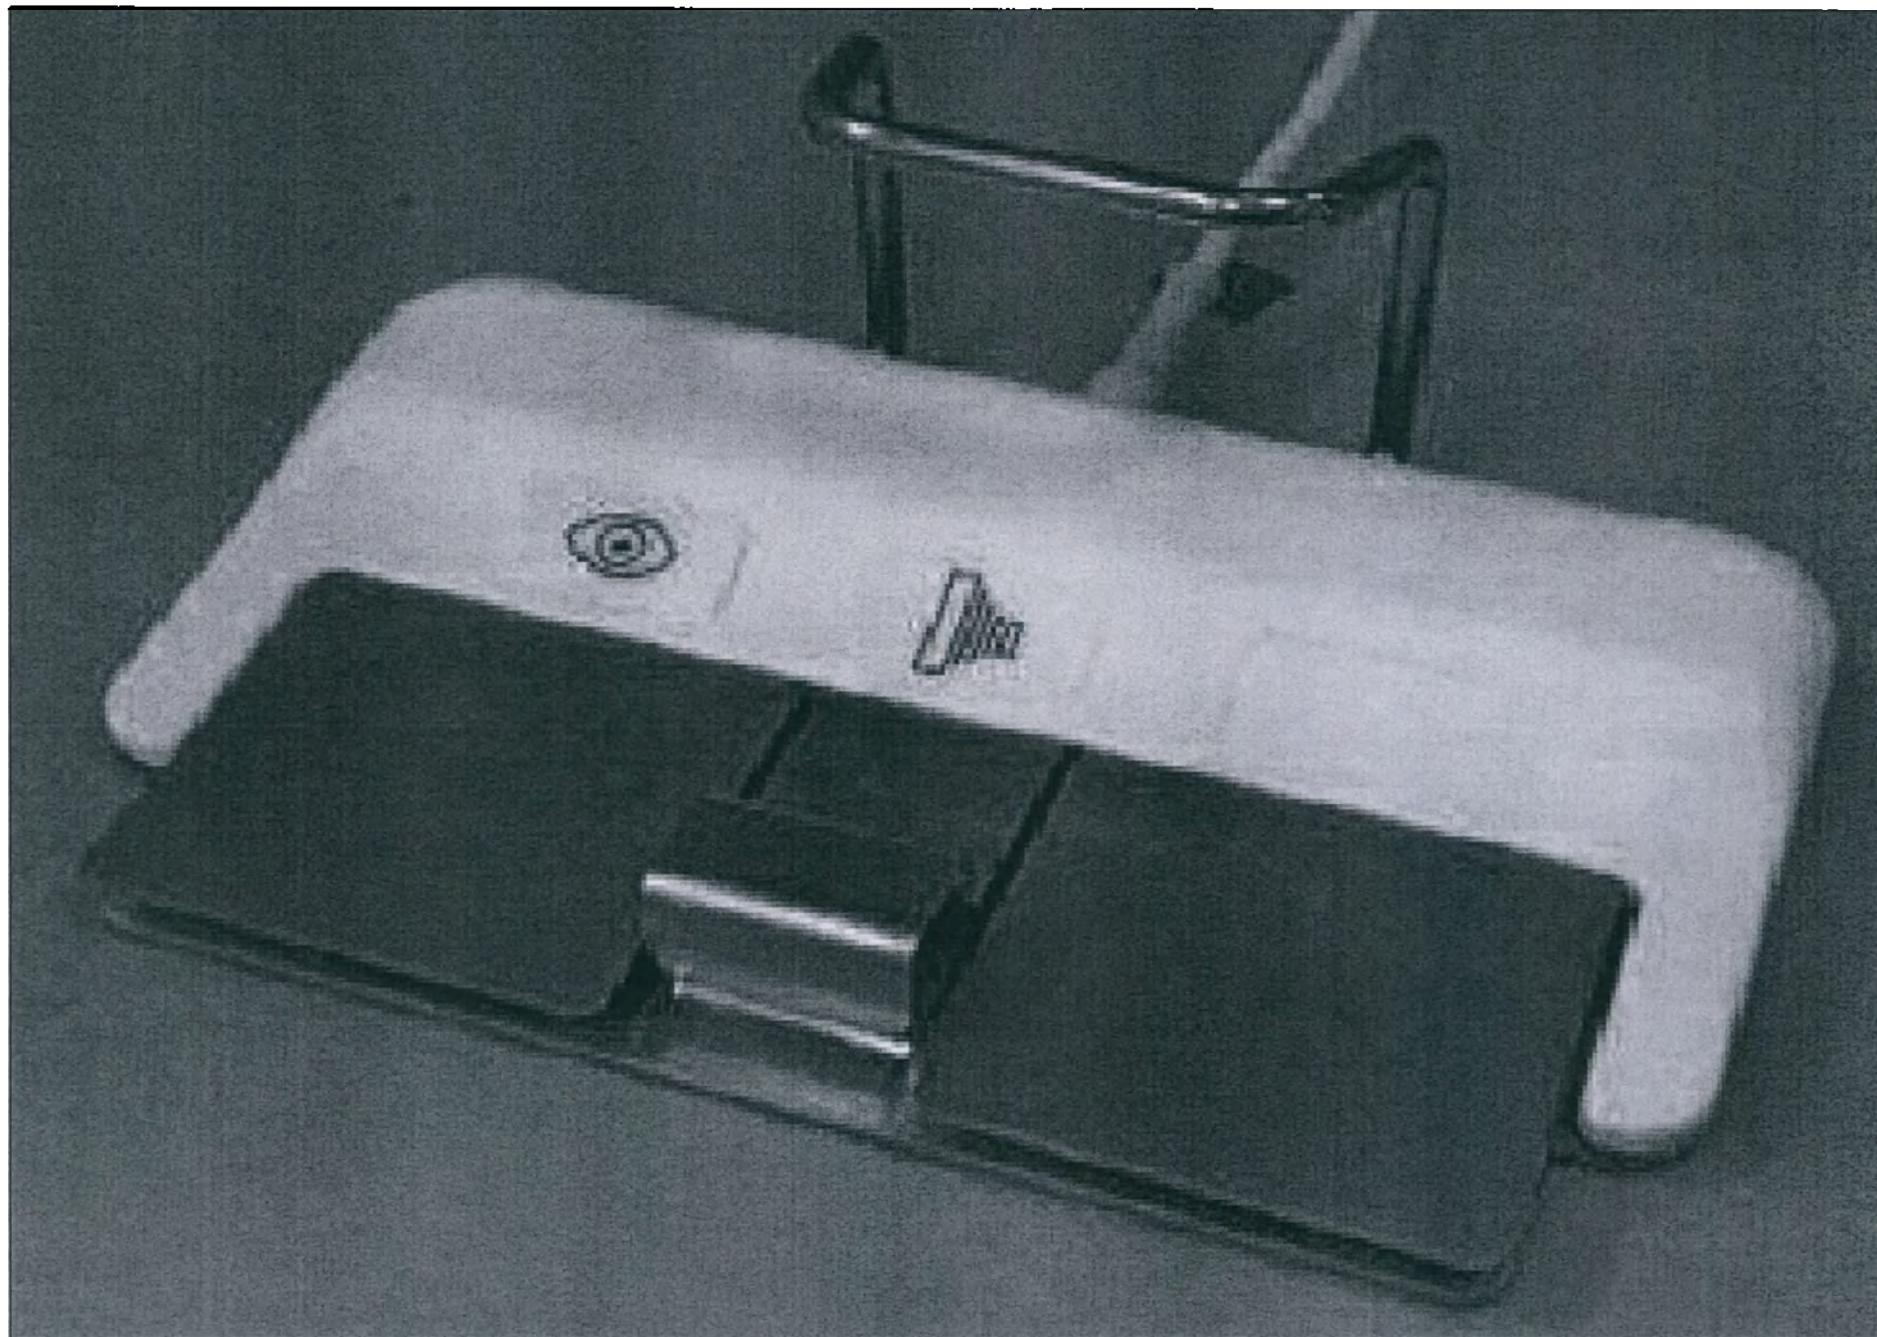


14. Ножной переключатель, не более 2 шт.

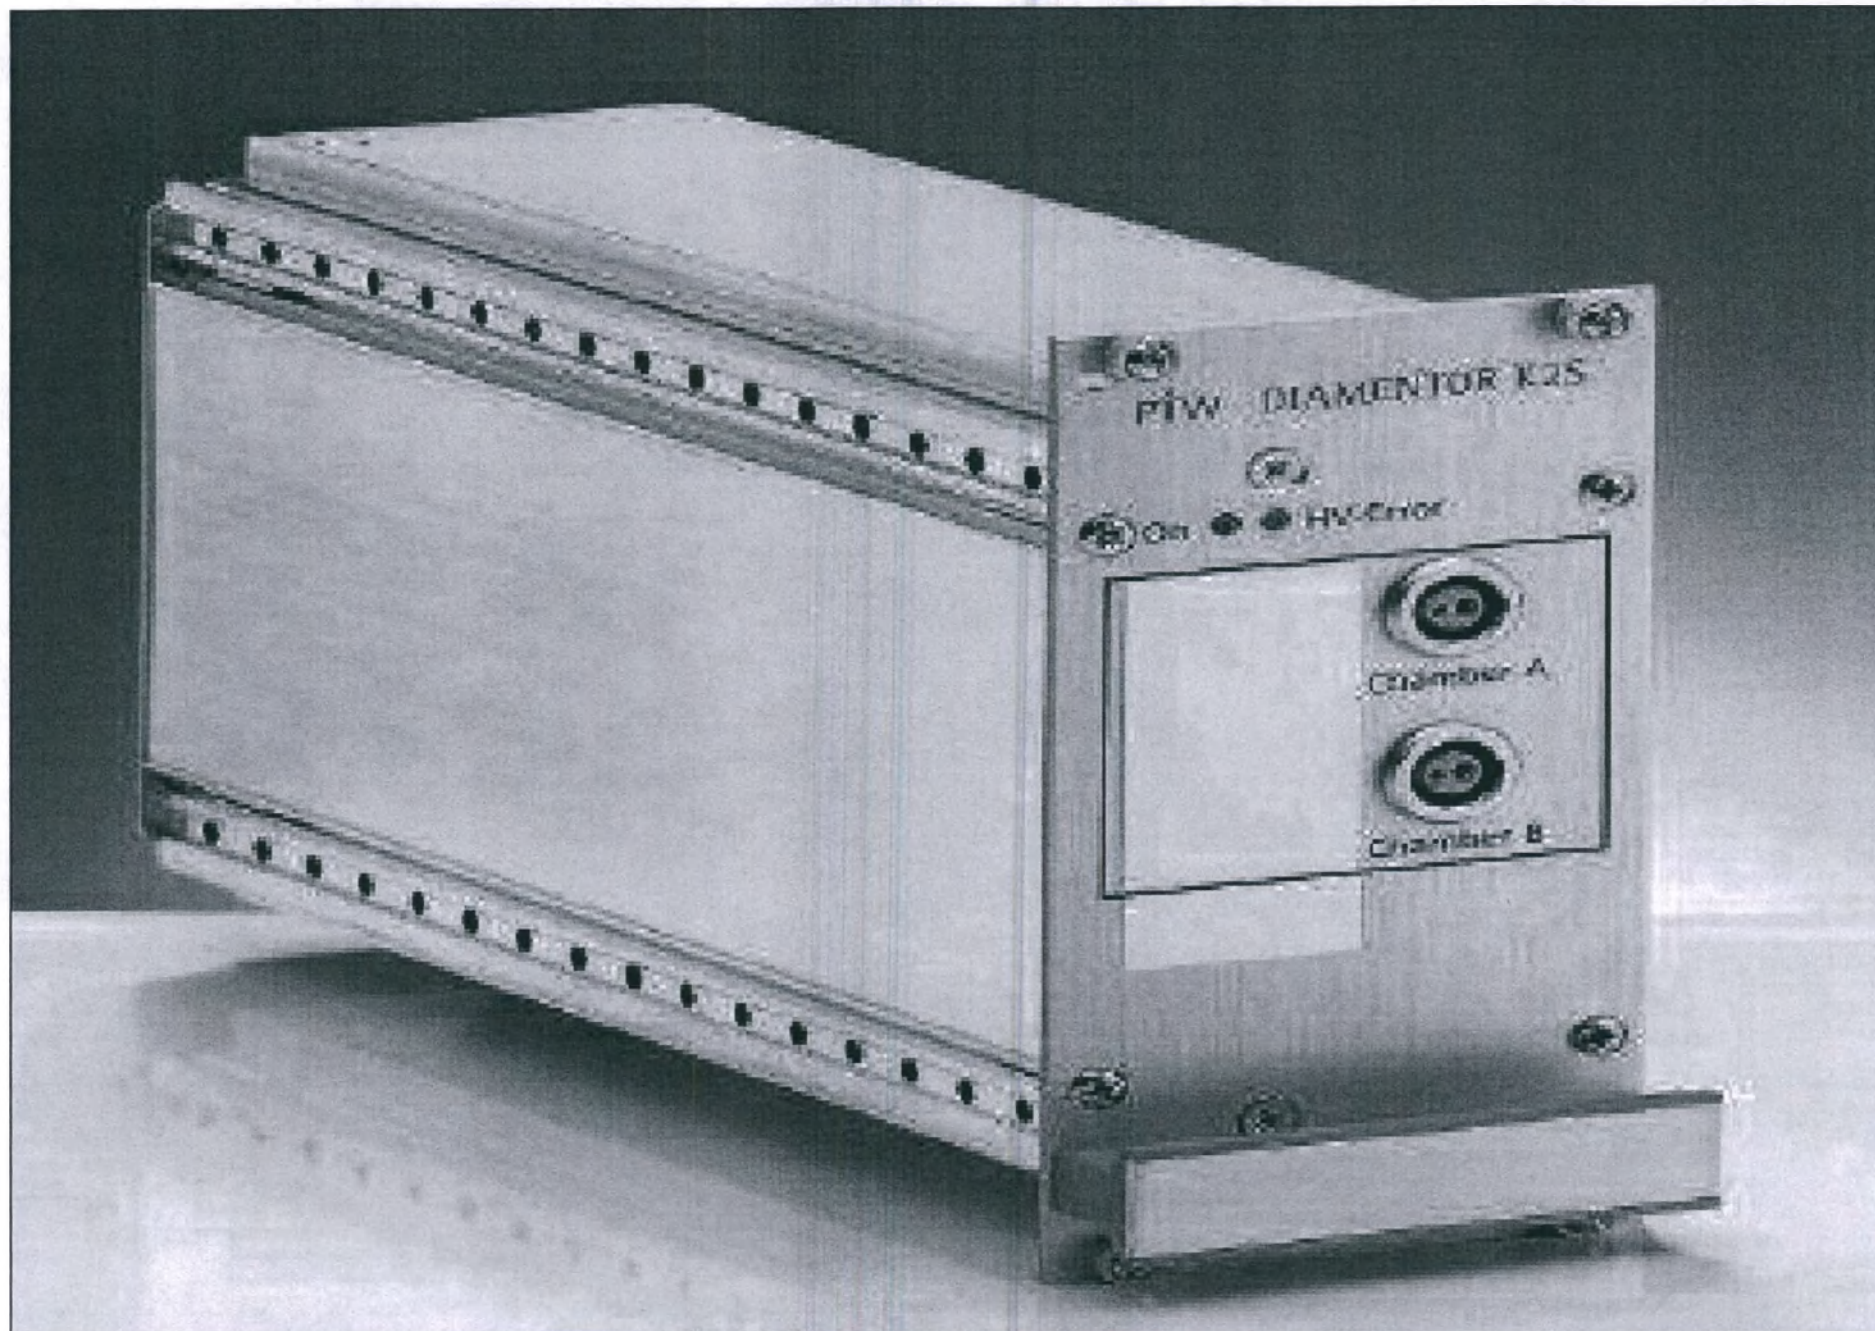


15.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

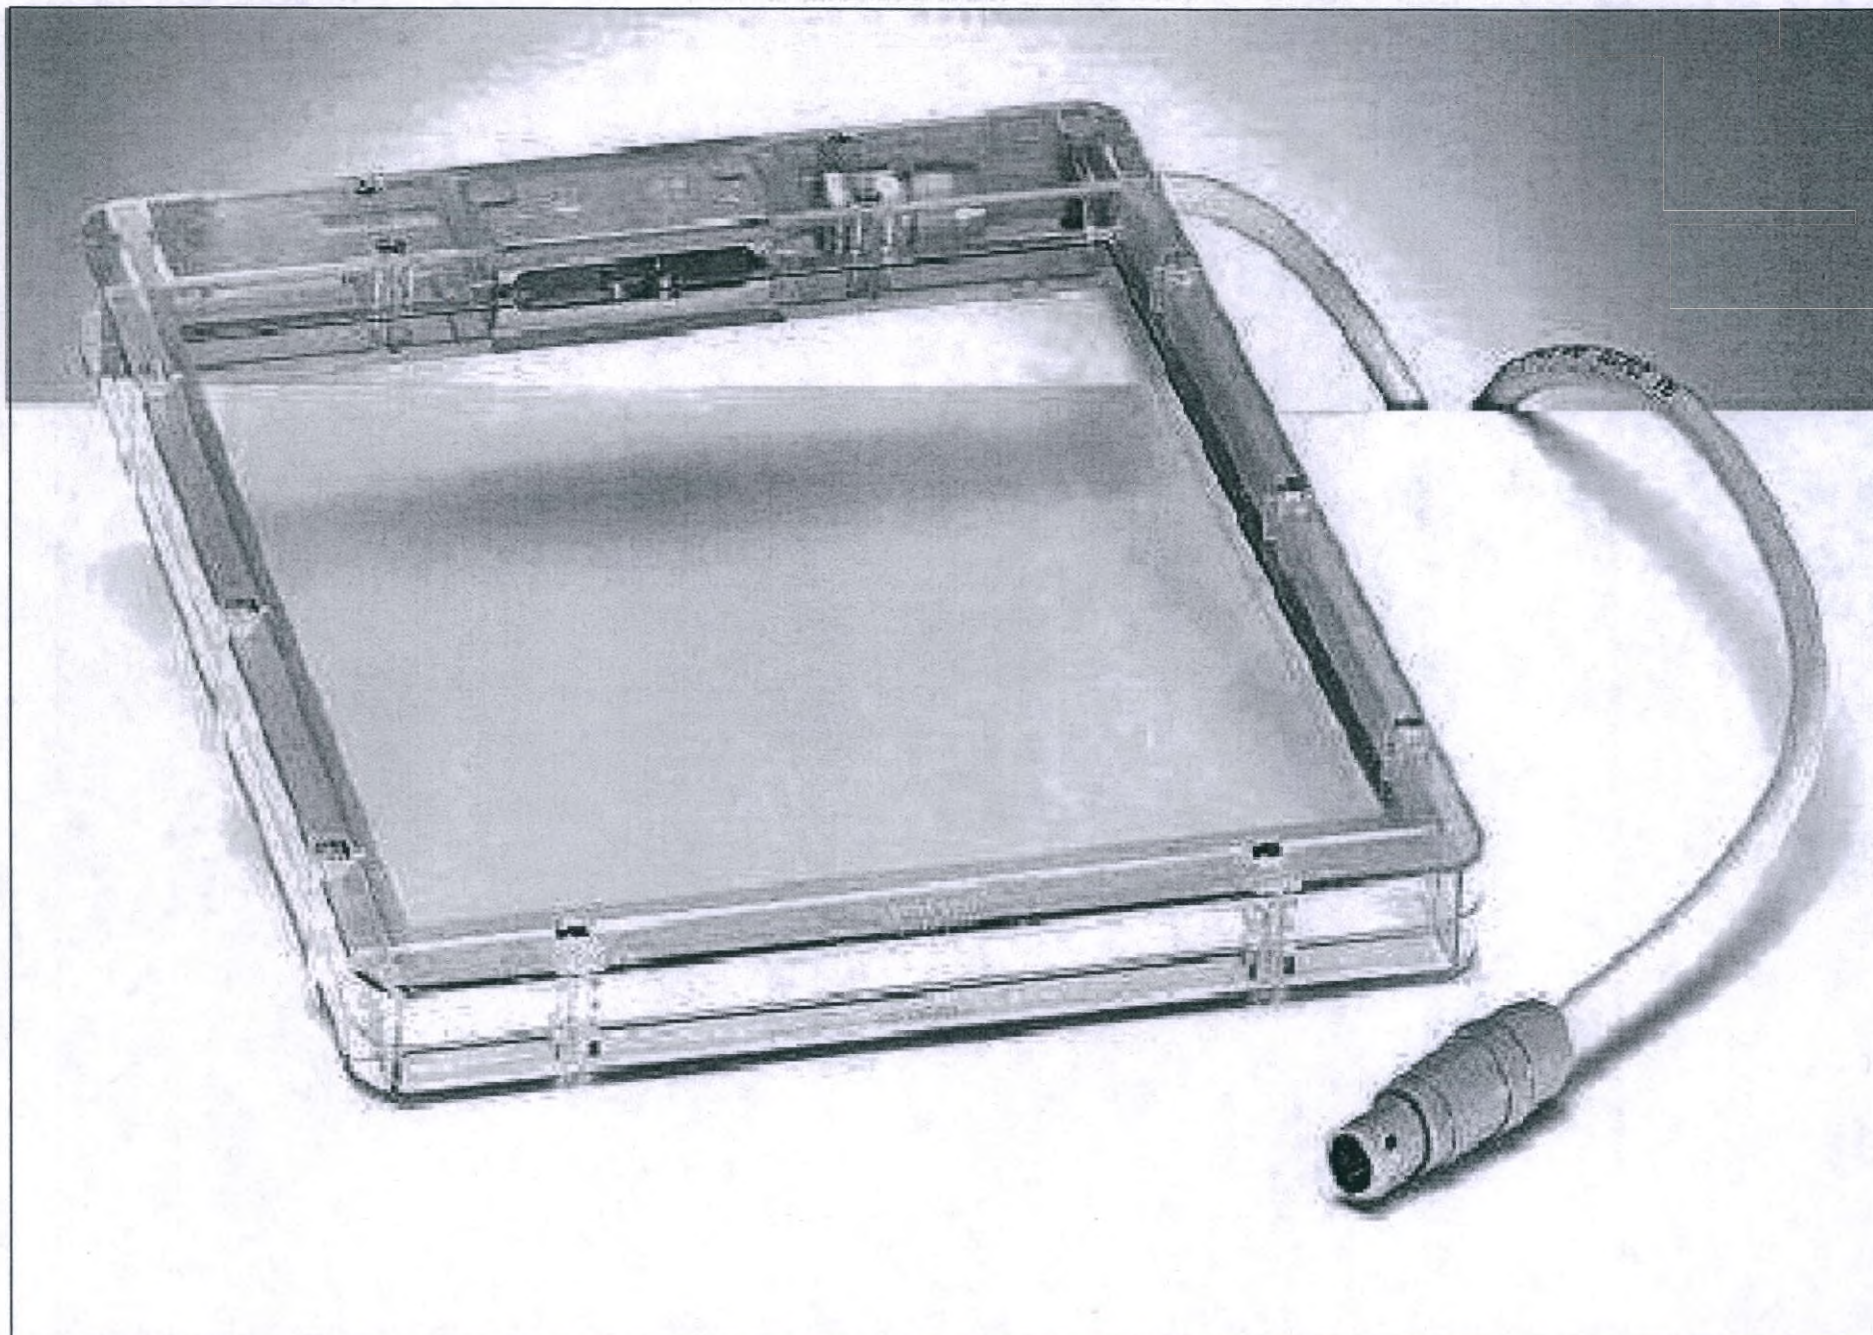


15.6. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДРК-1* или *ДРК-1М*.

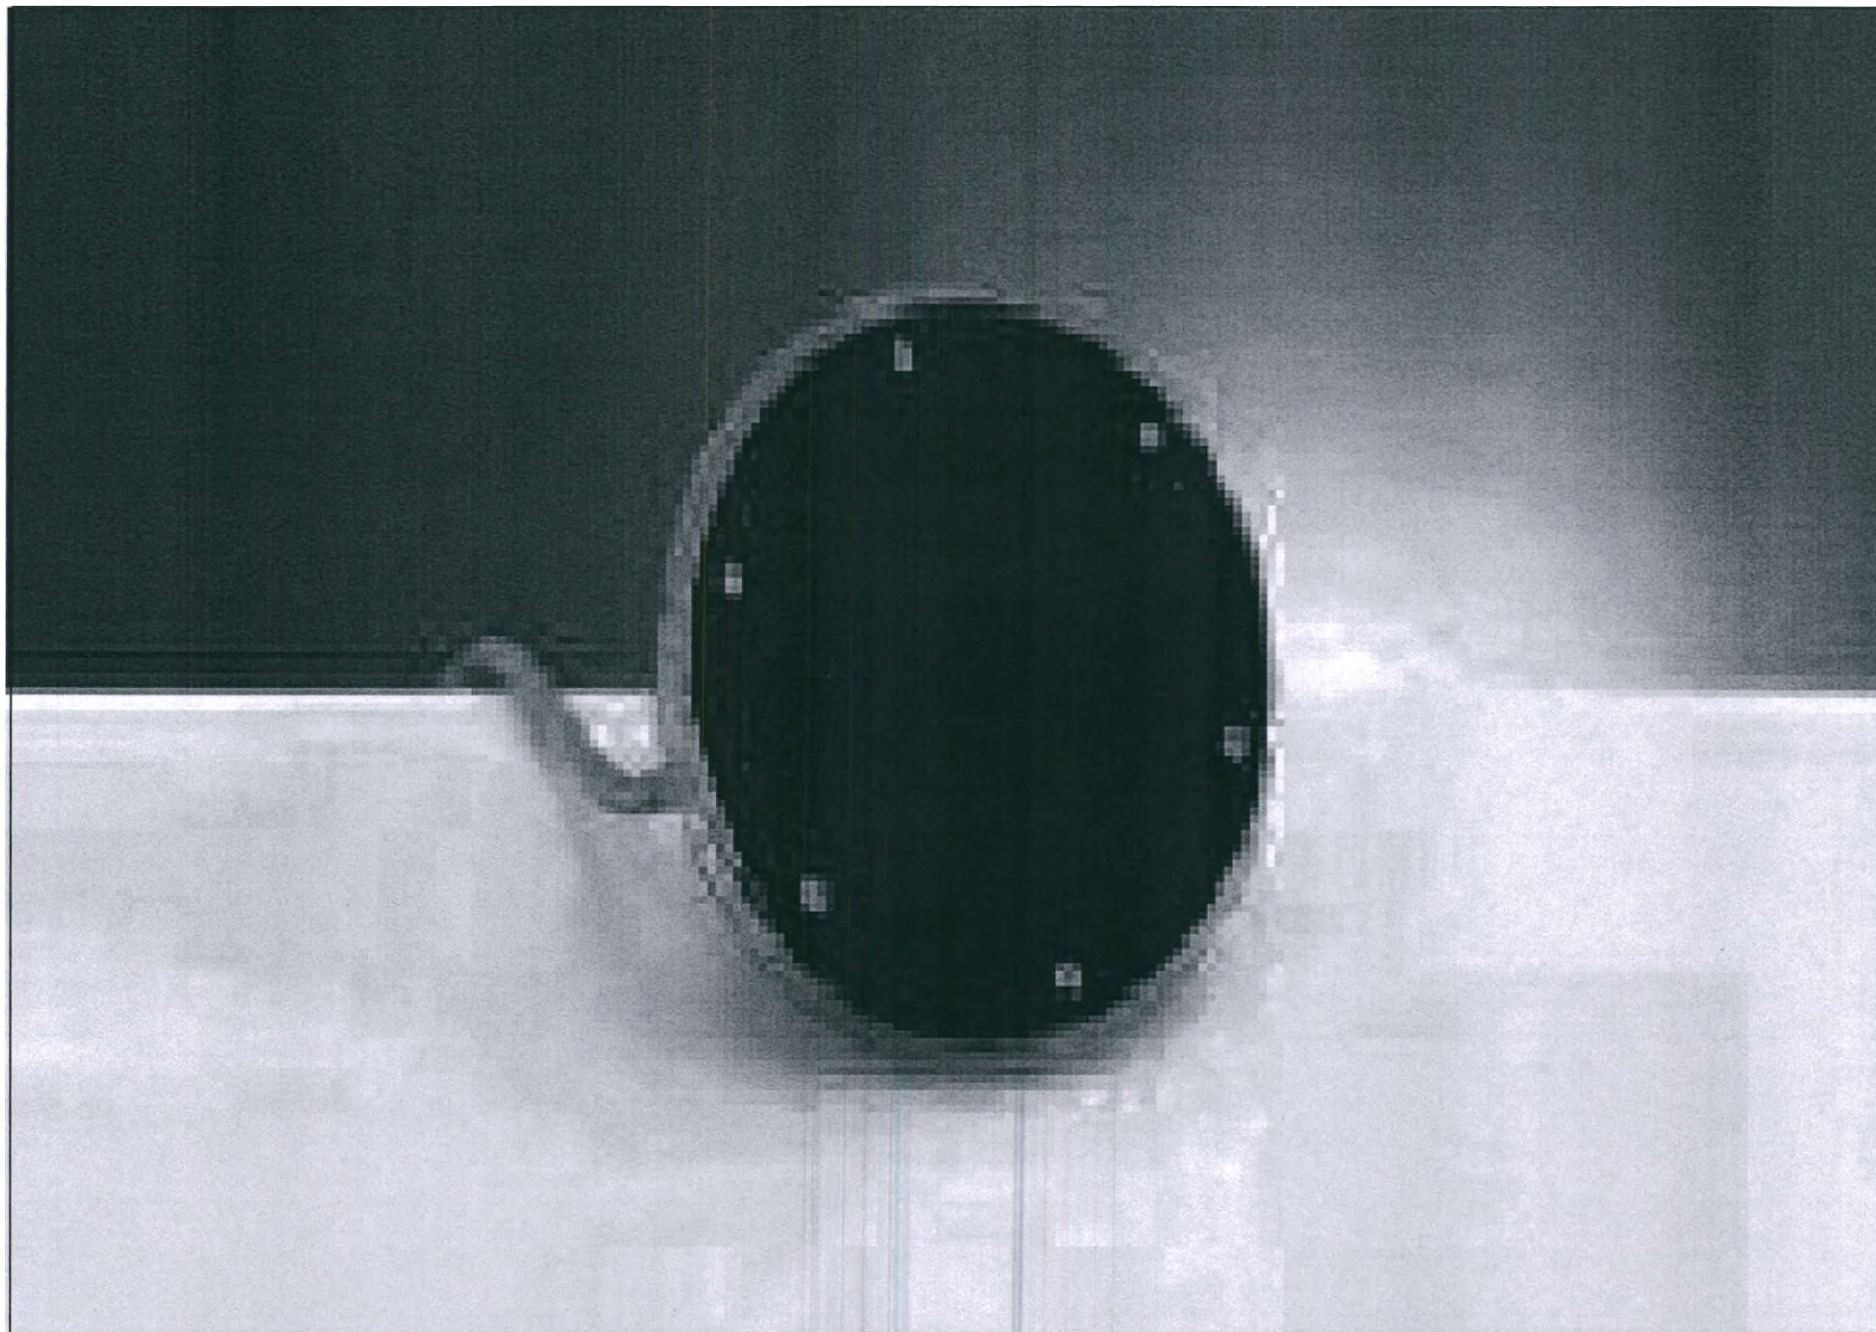


5.в. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

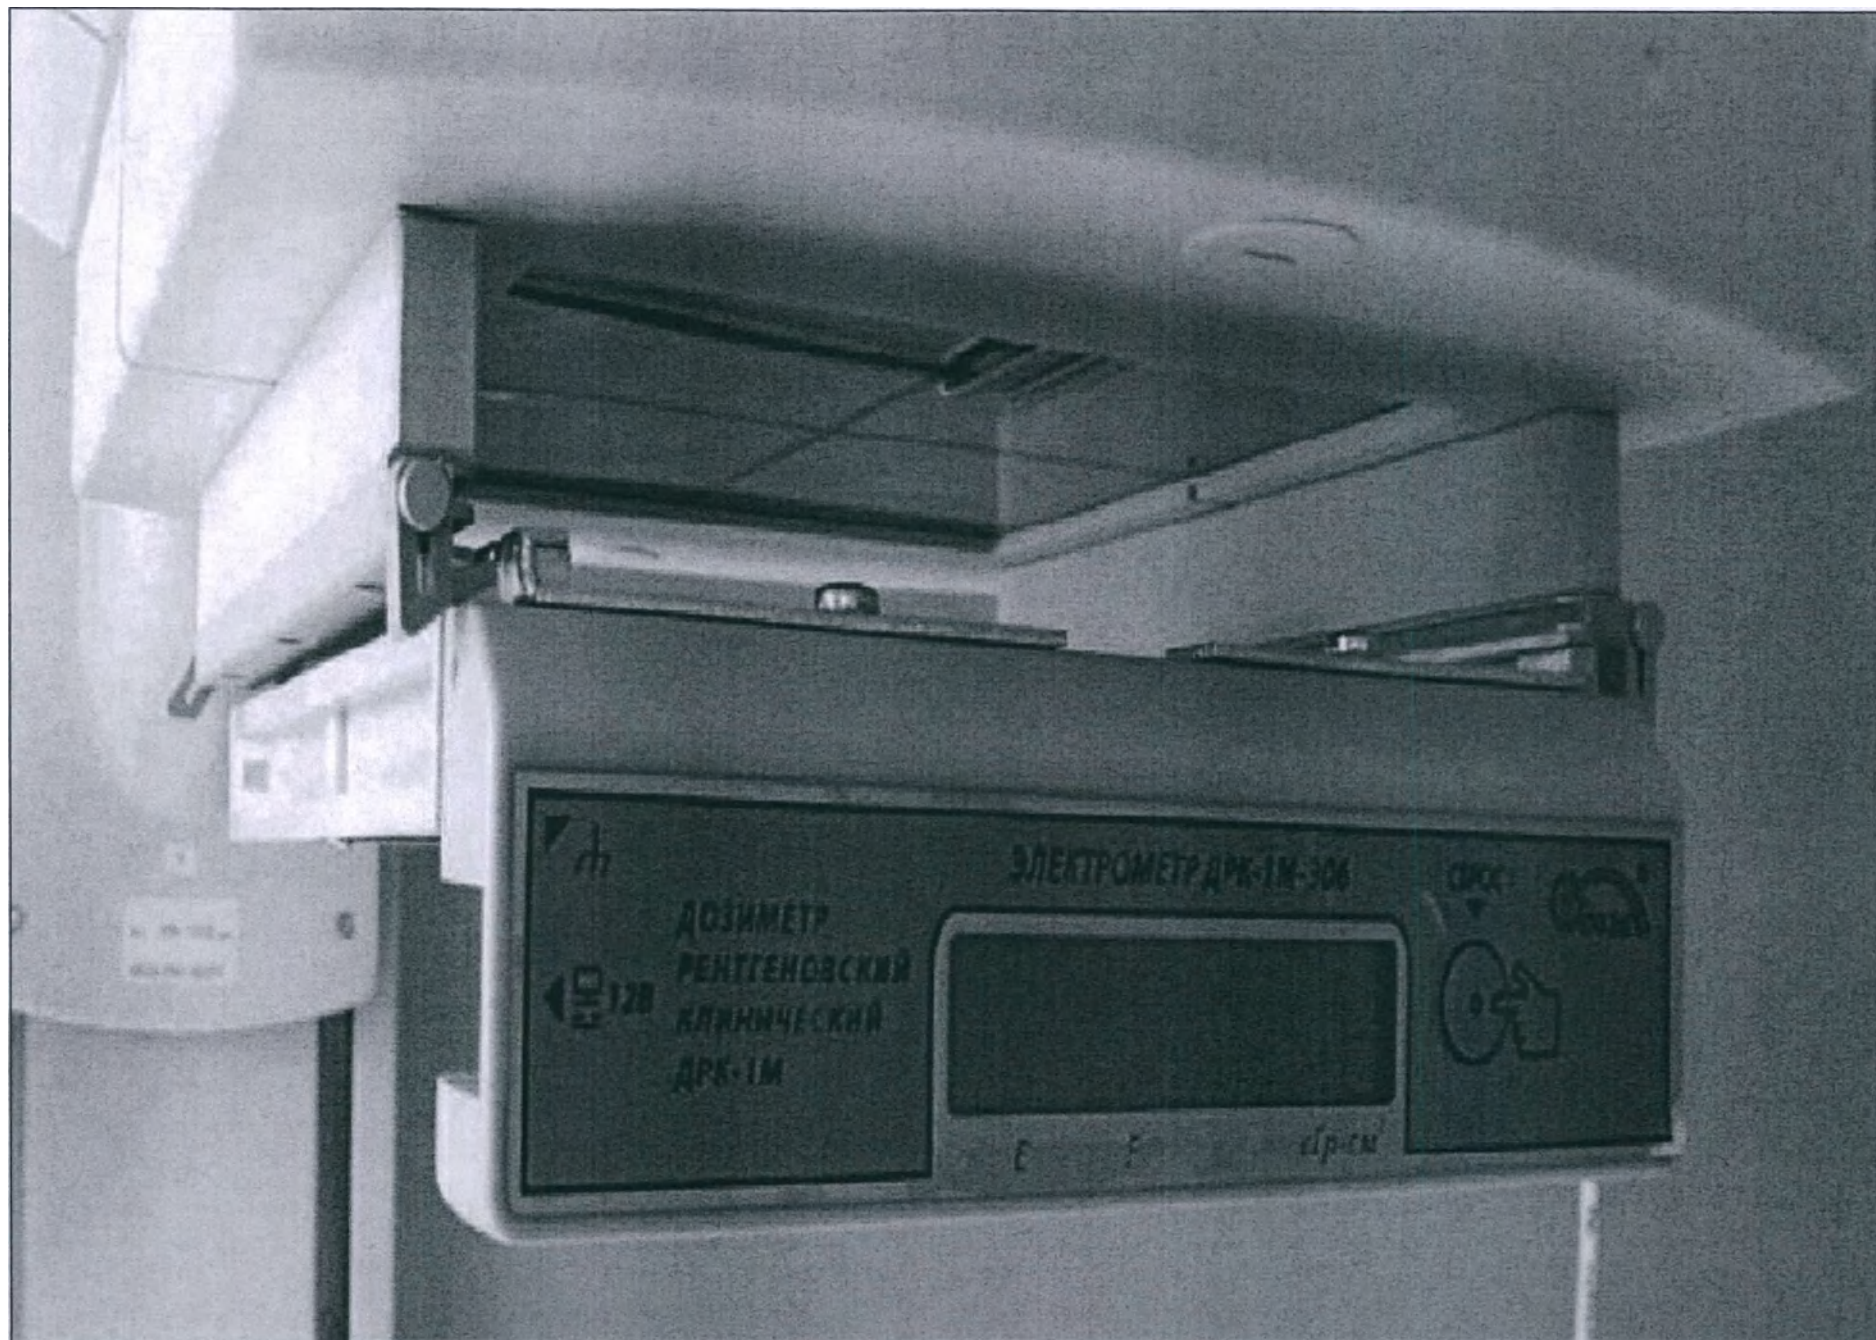


15.2. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

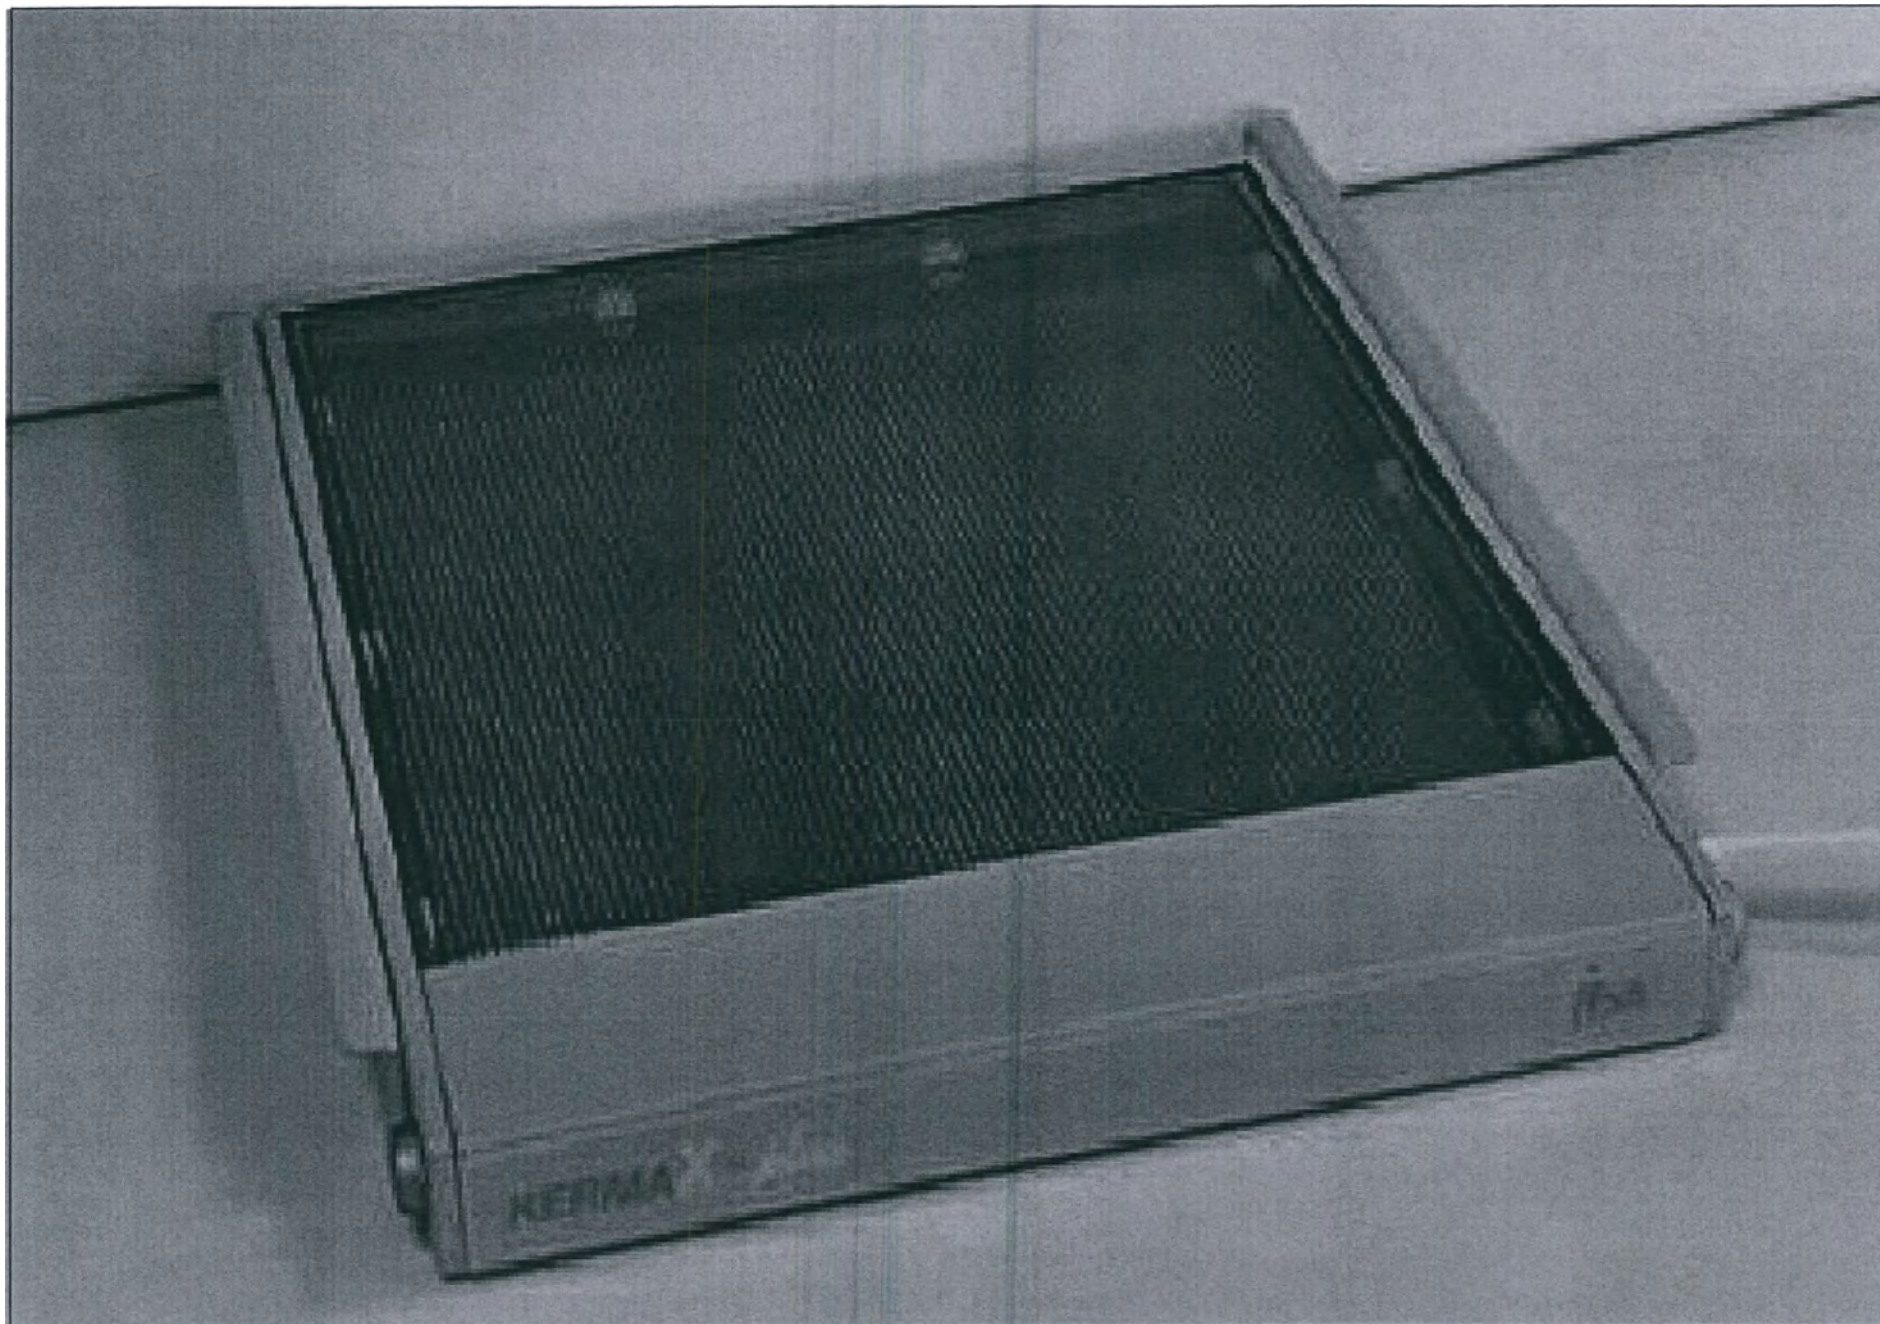


16. Измеритель производства дозы на площадь Kertax plus 120-132.

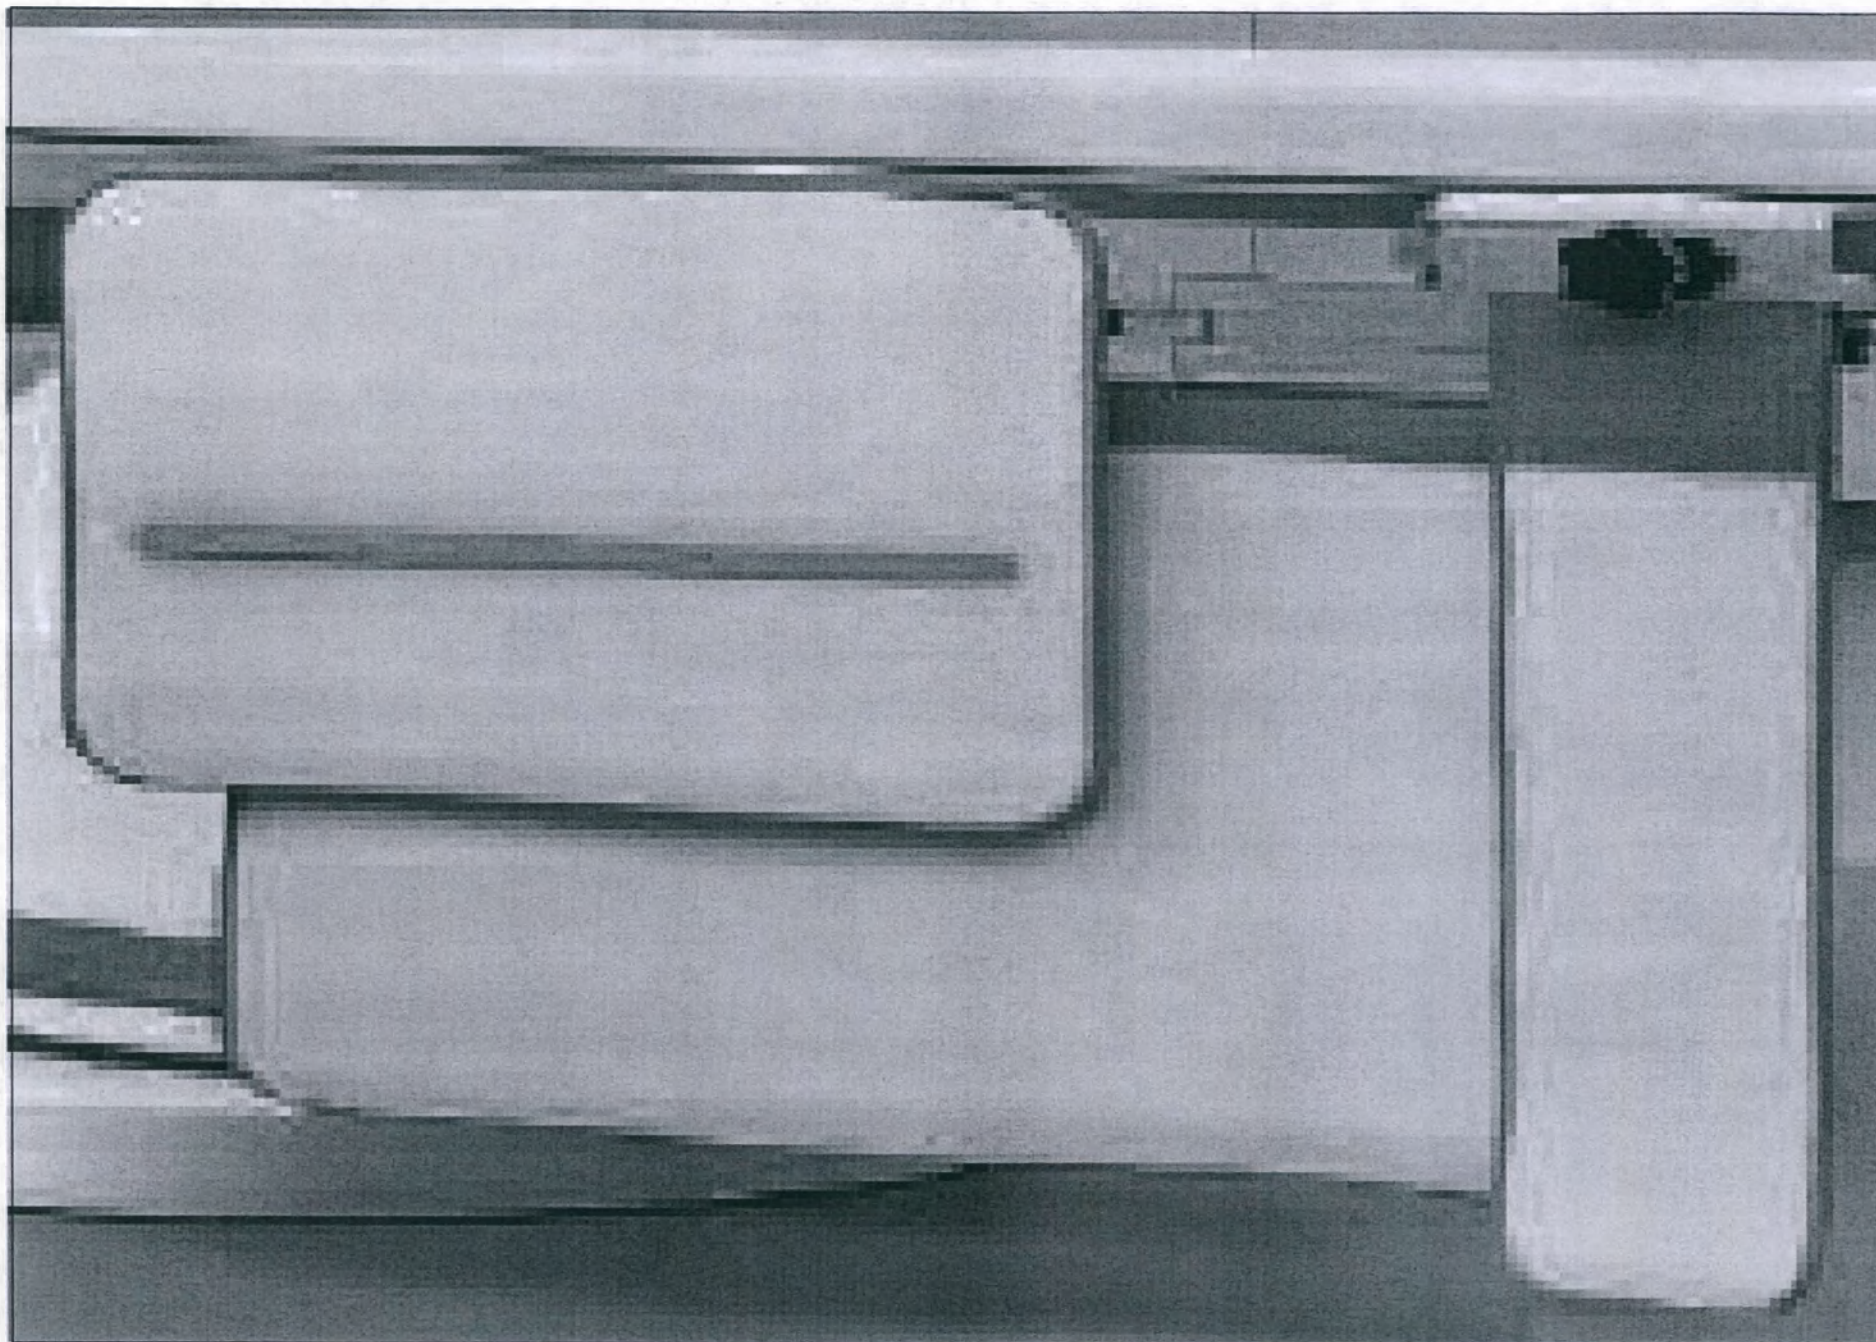


17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

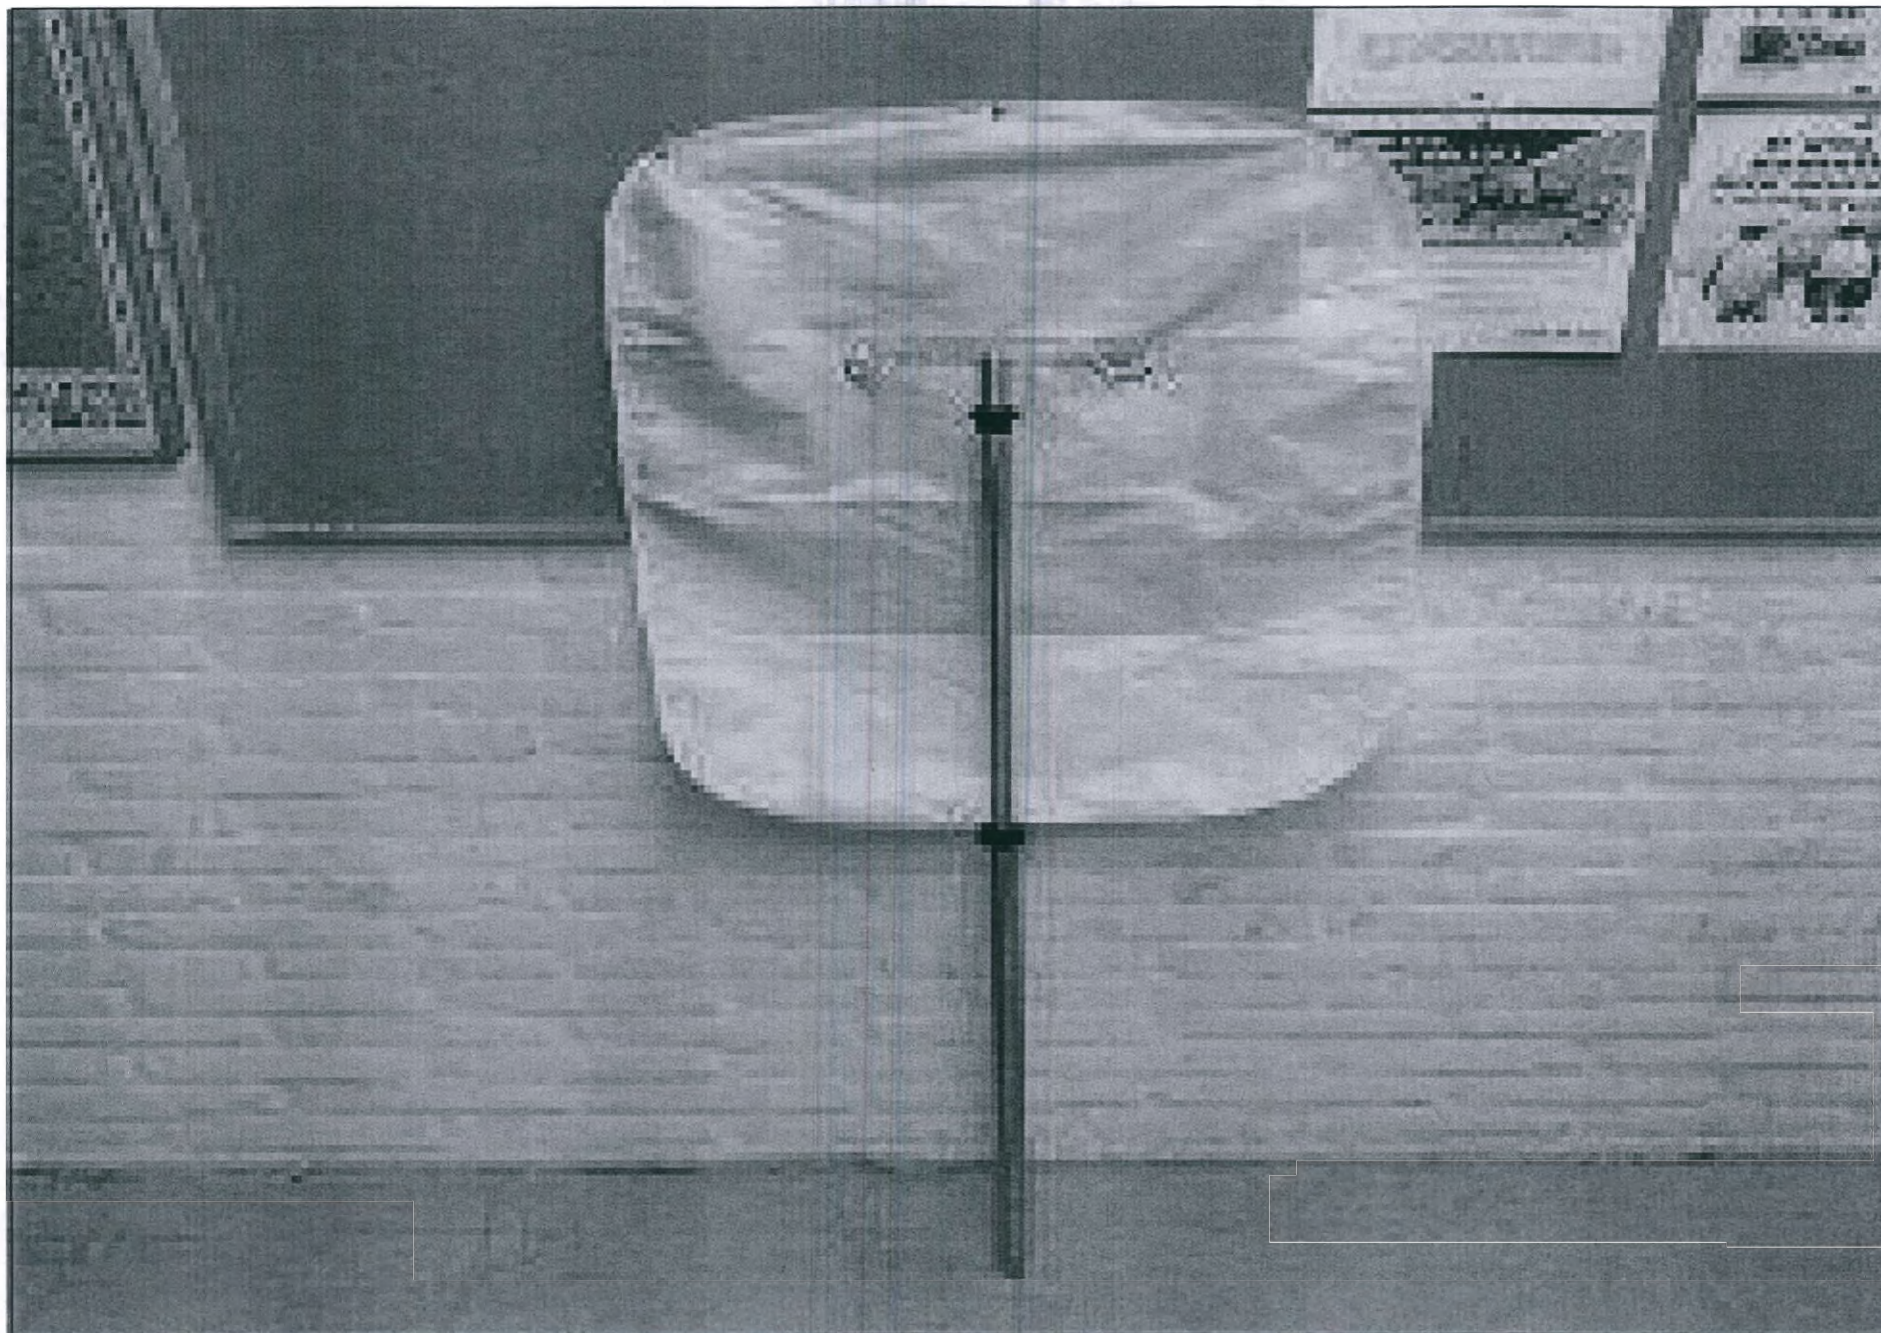


18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

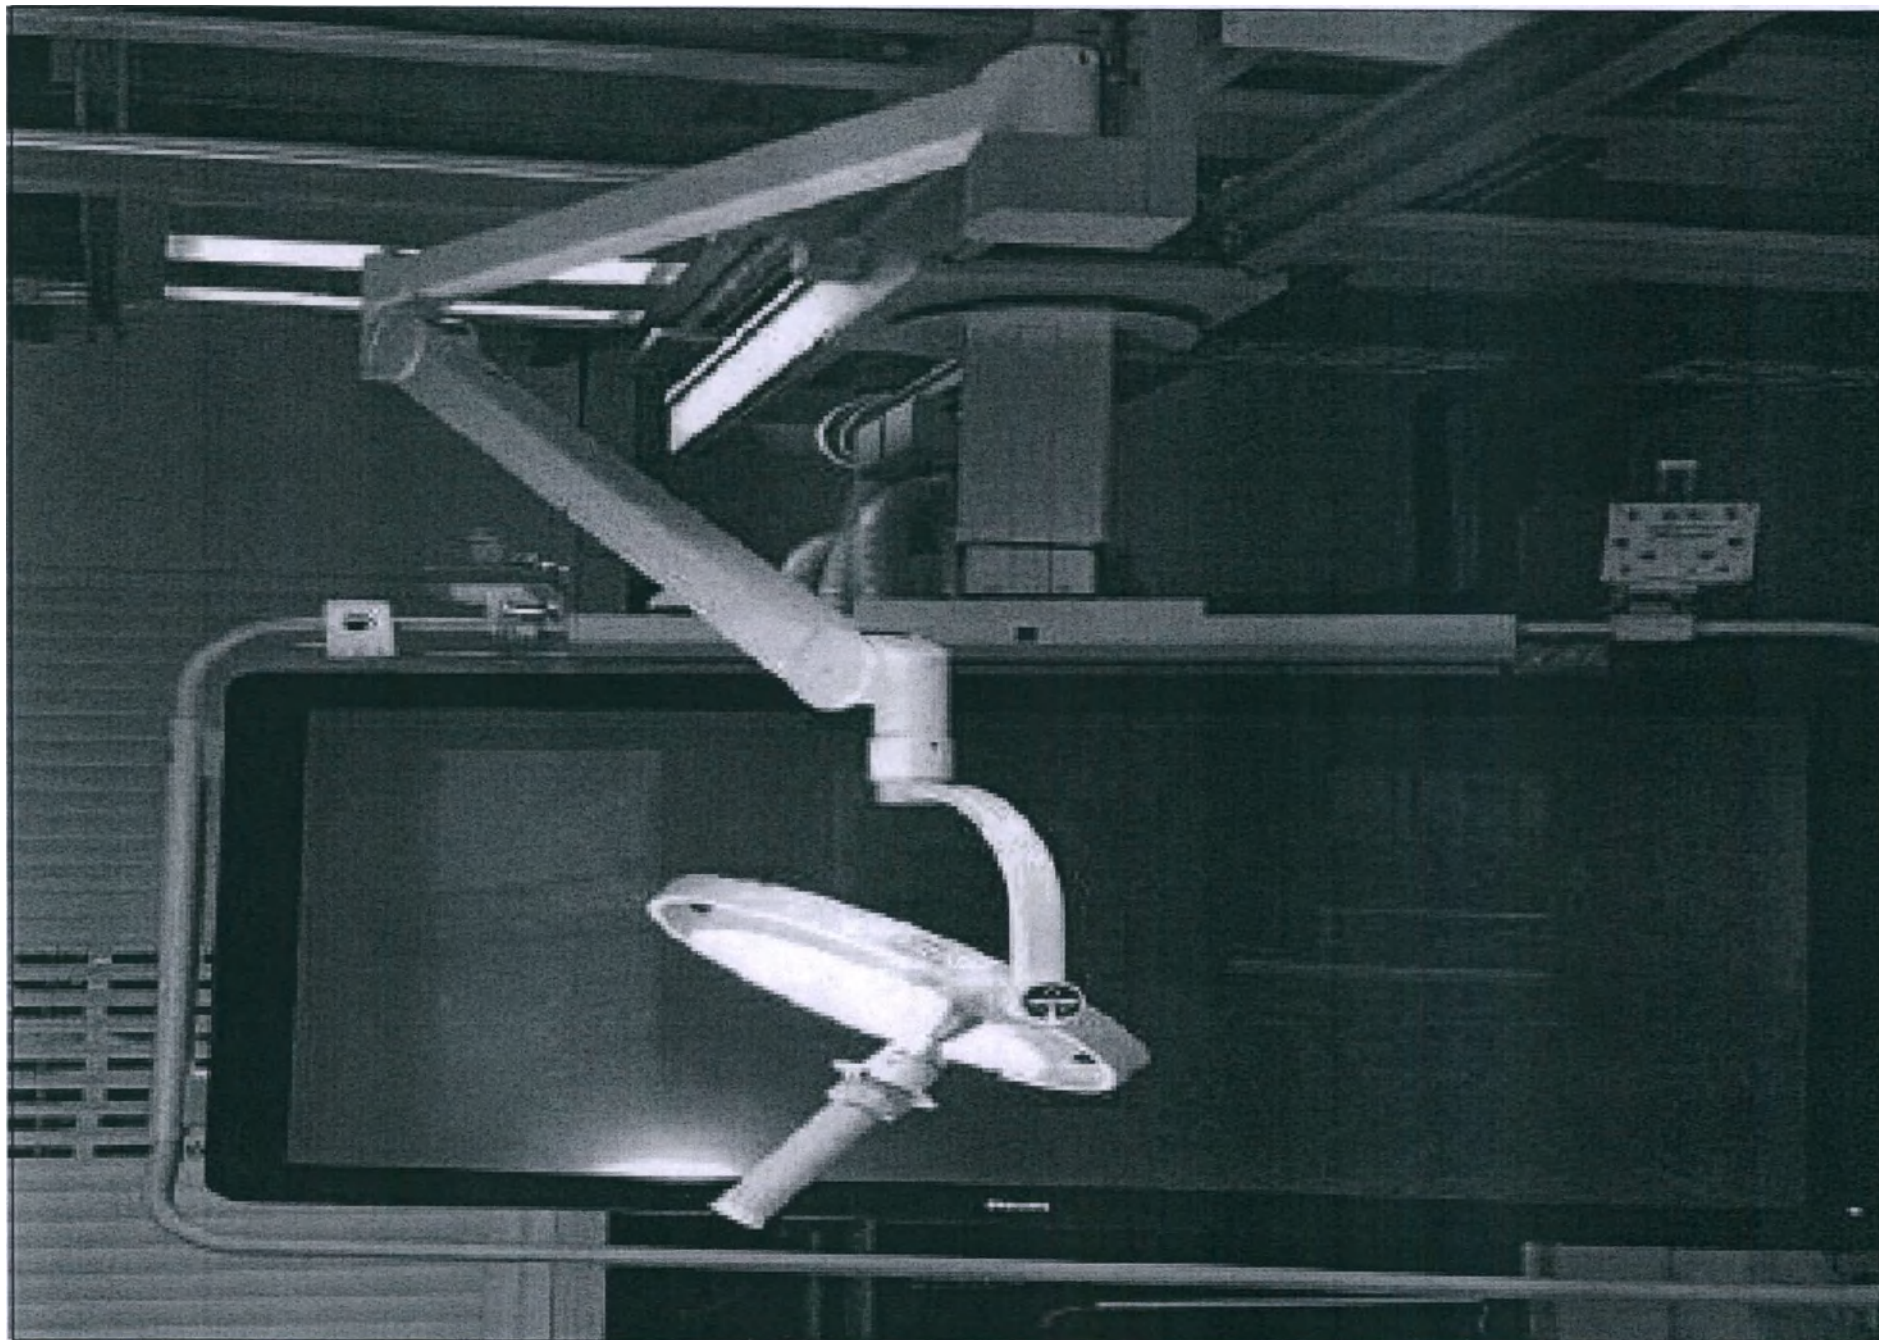

19. Лампа для осмотра

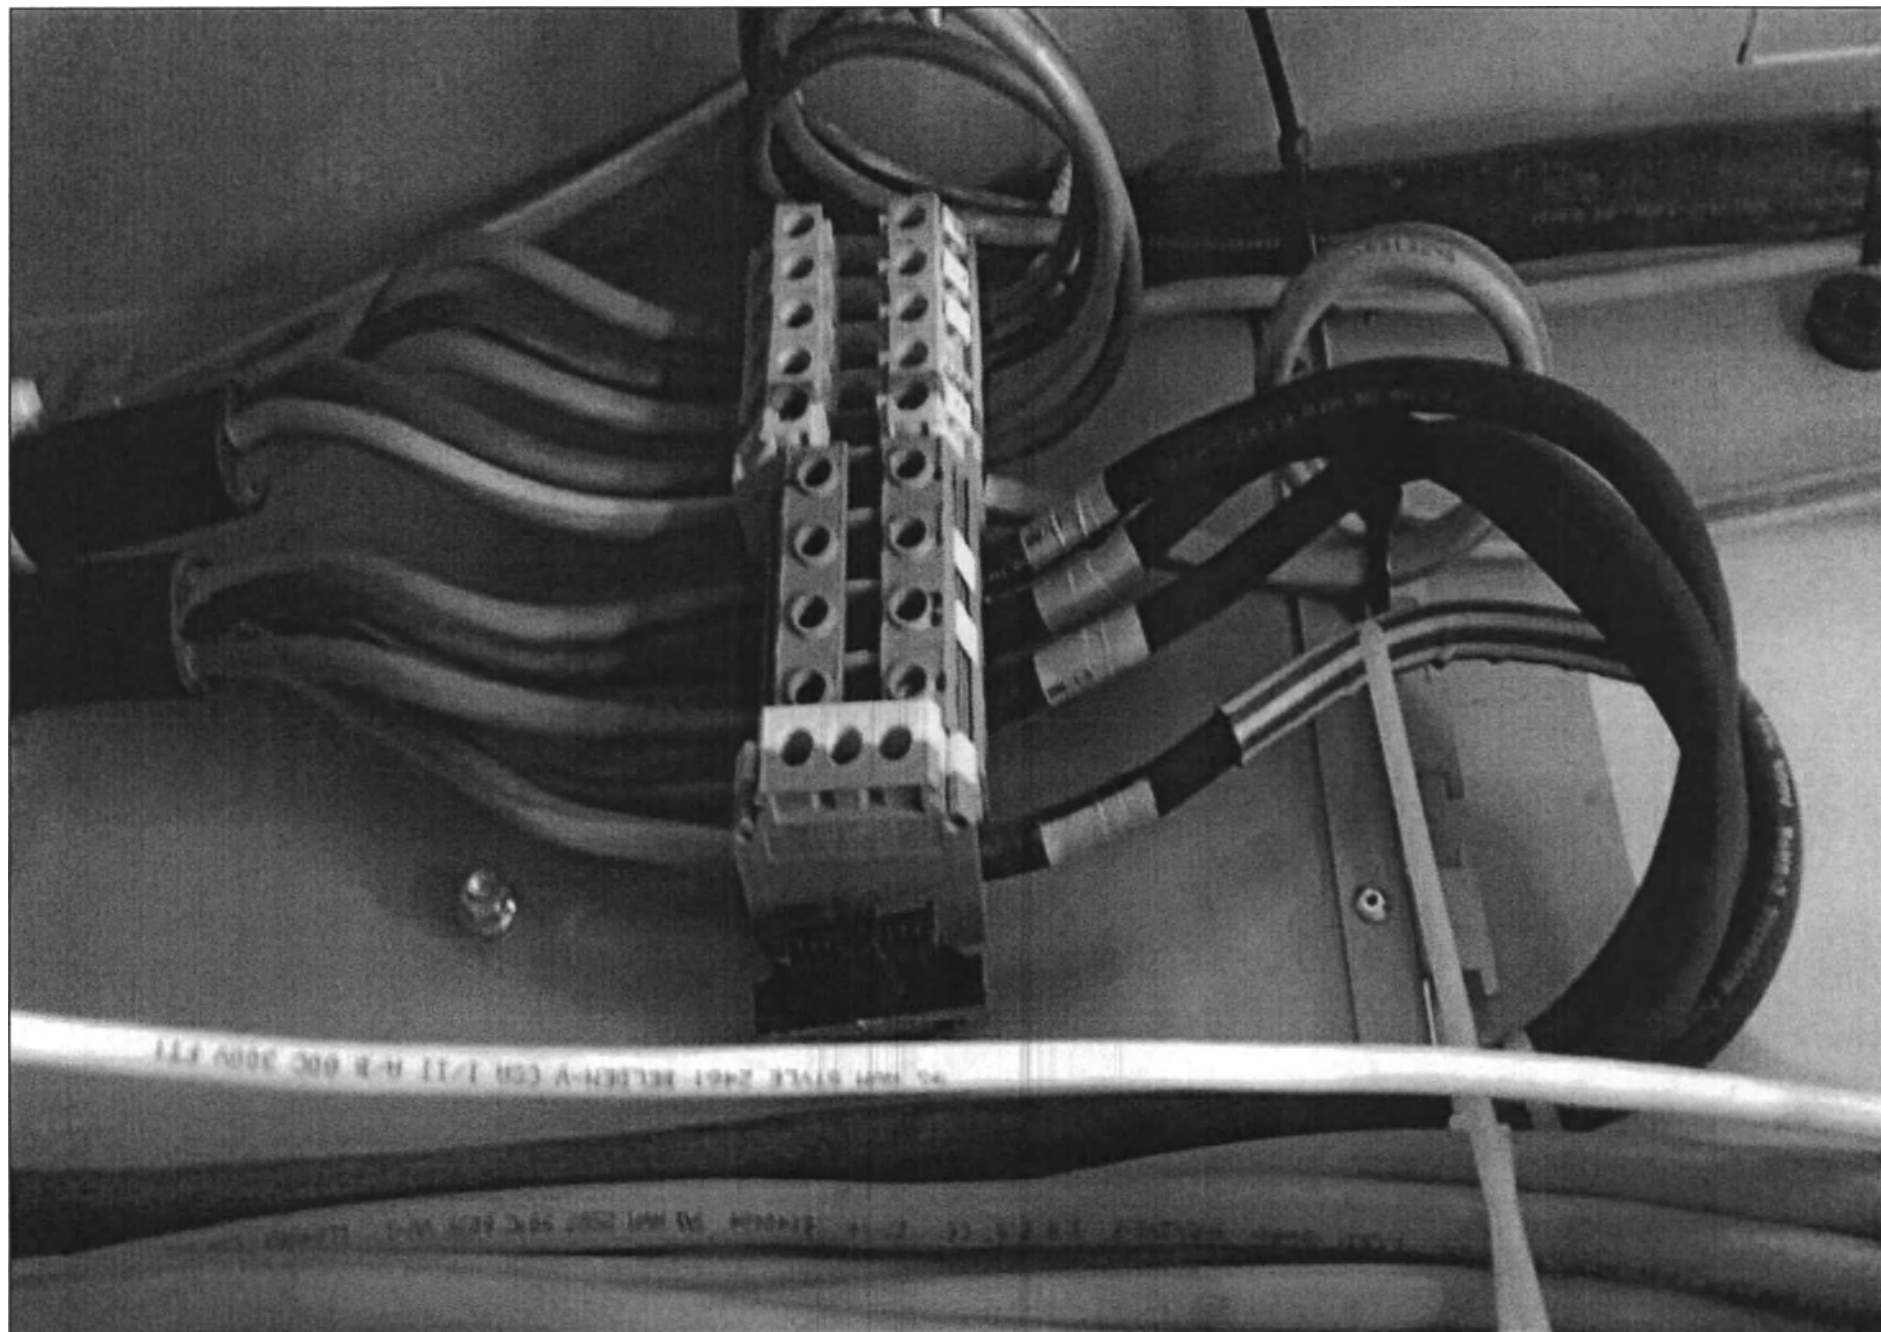

20. Кабели питания, 10 шт.

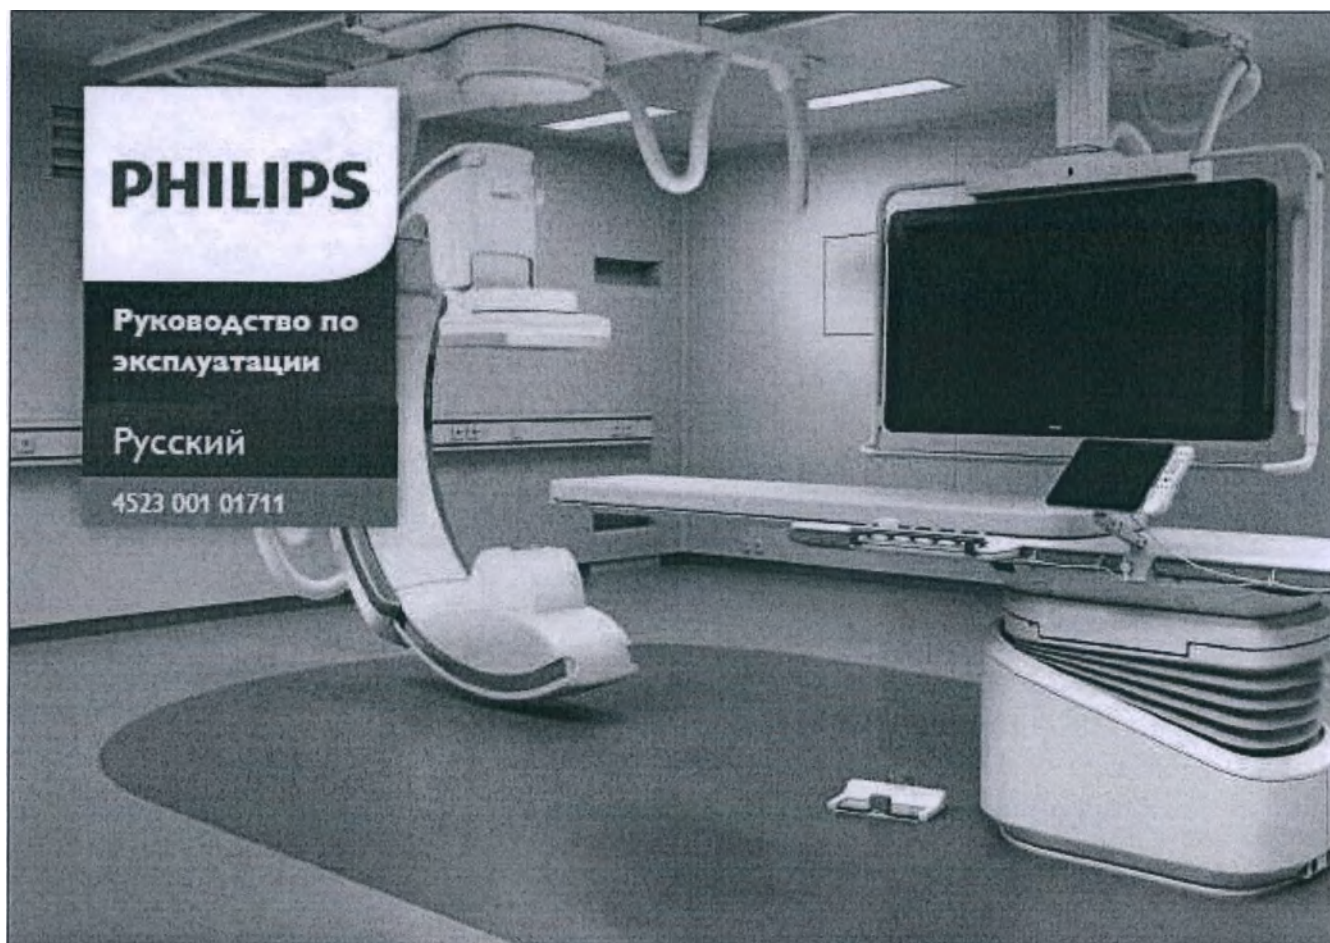

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский


4523 001 01711

Philips Azurion


Версия 2.2

21.в. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 3 M15:

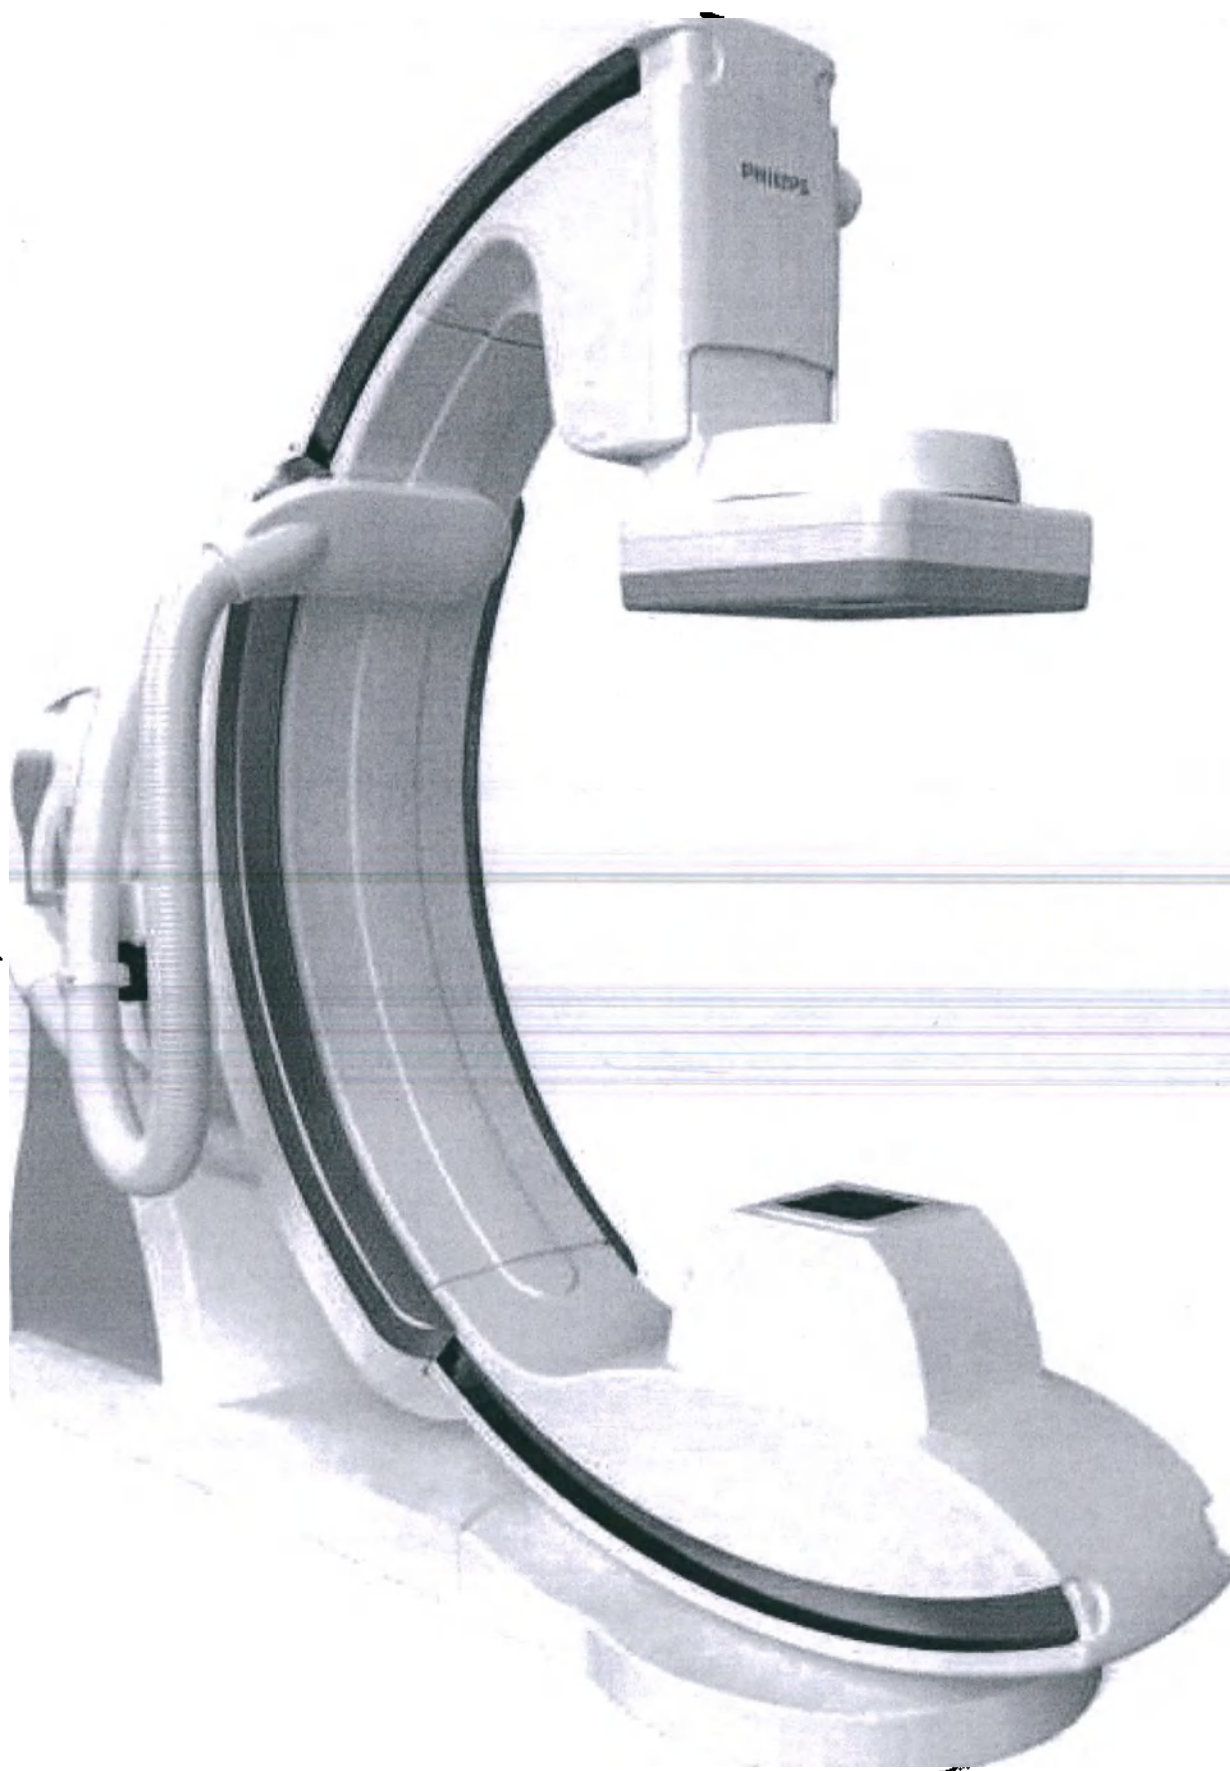


1. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F15.

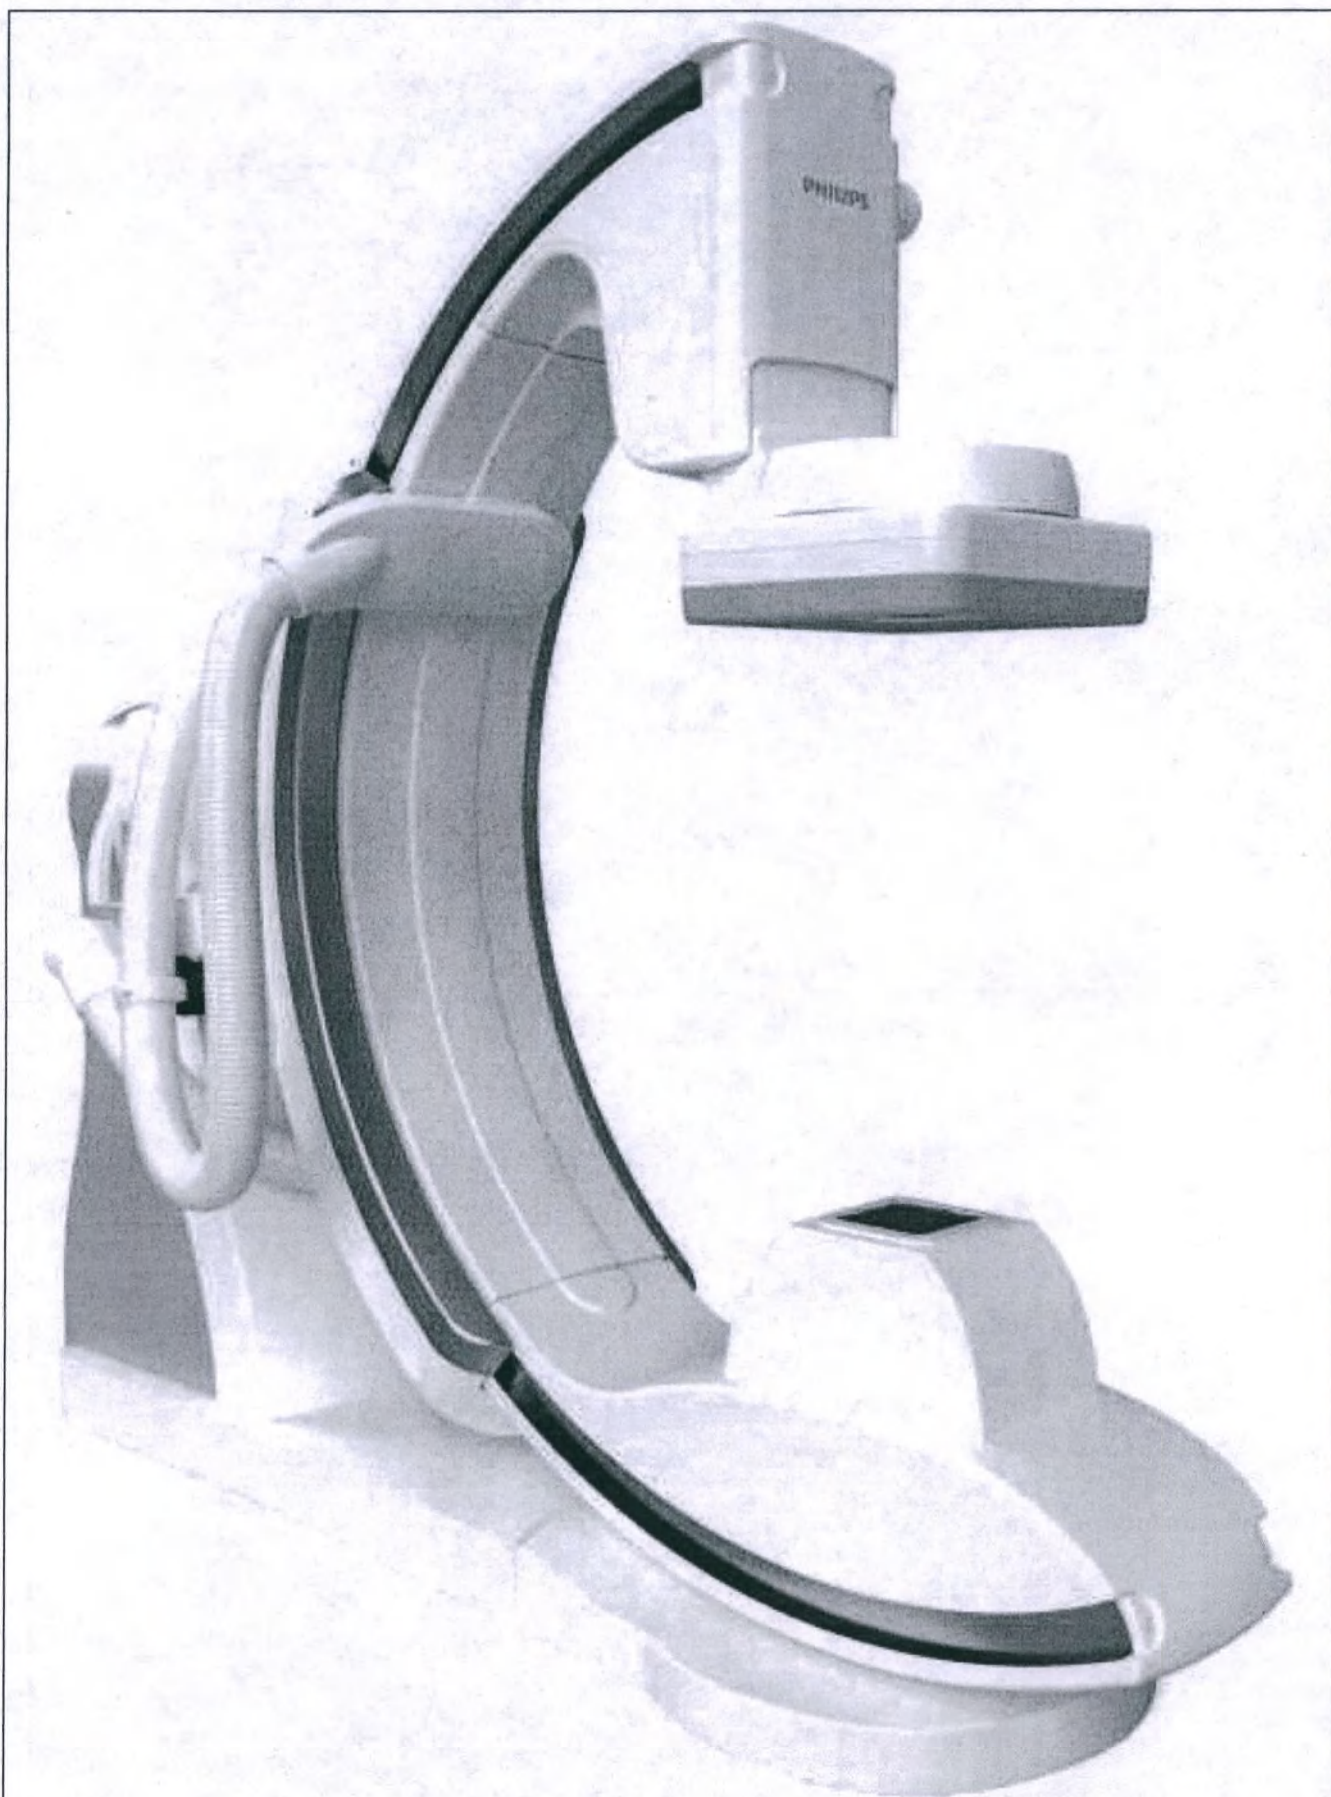


1.а. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F15.

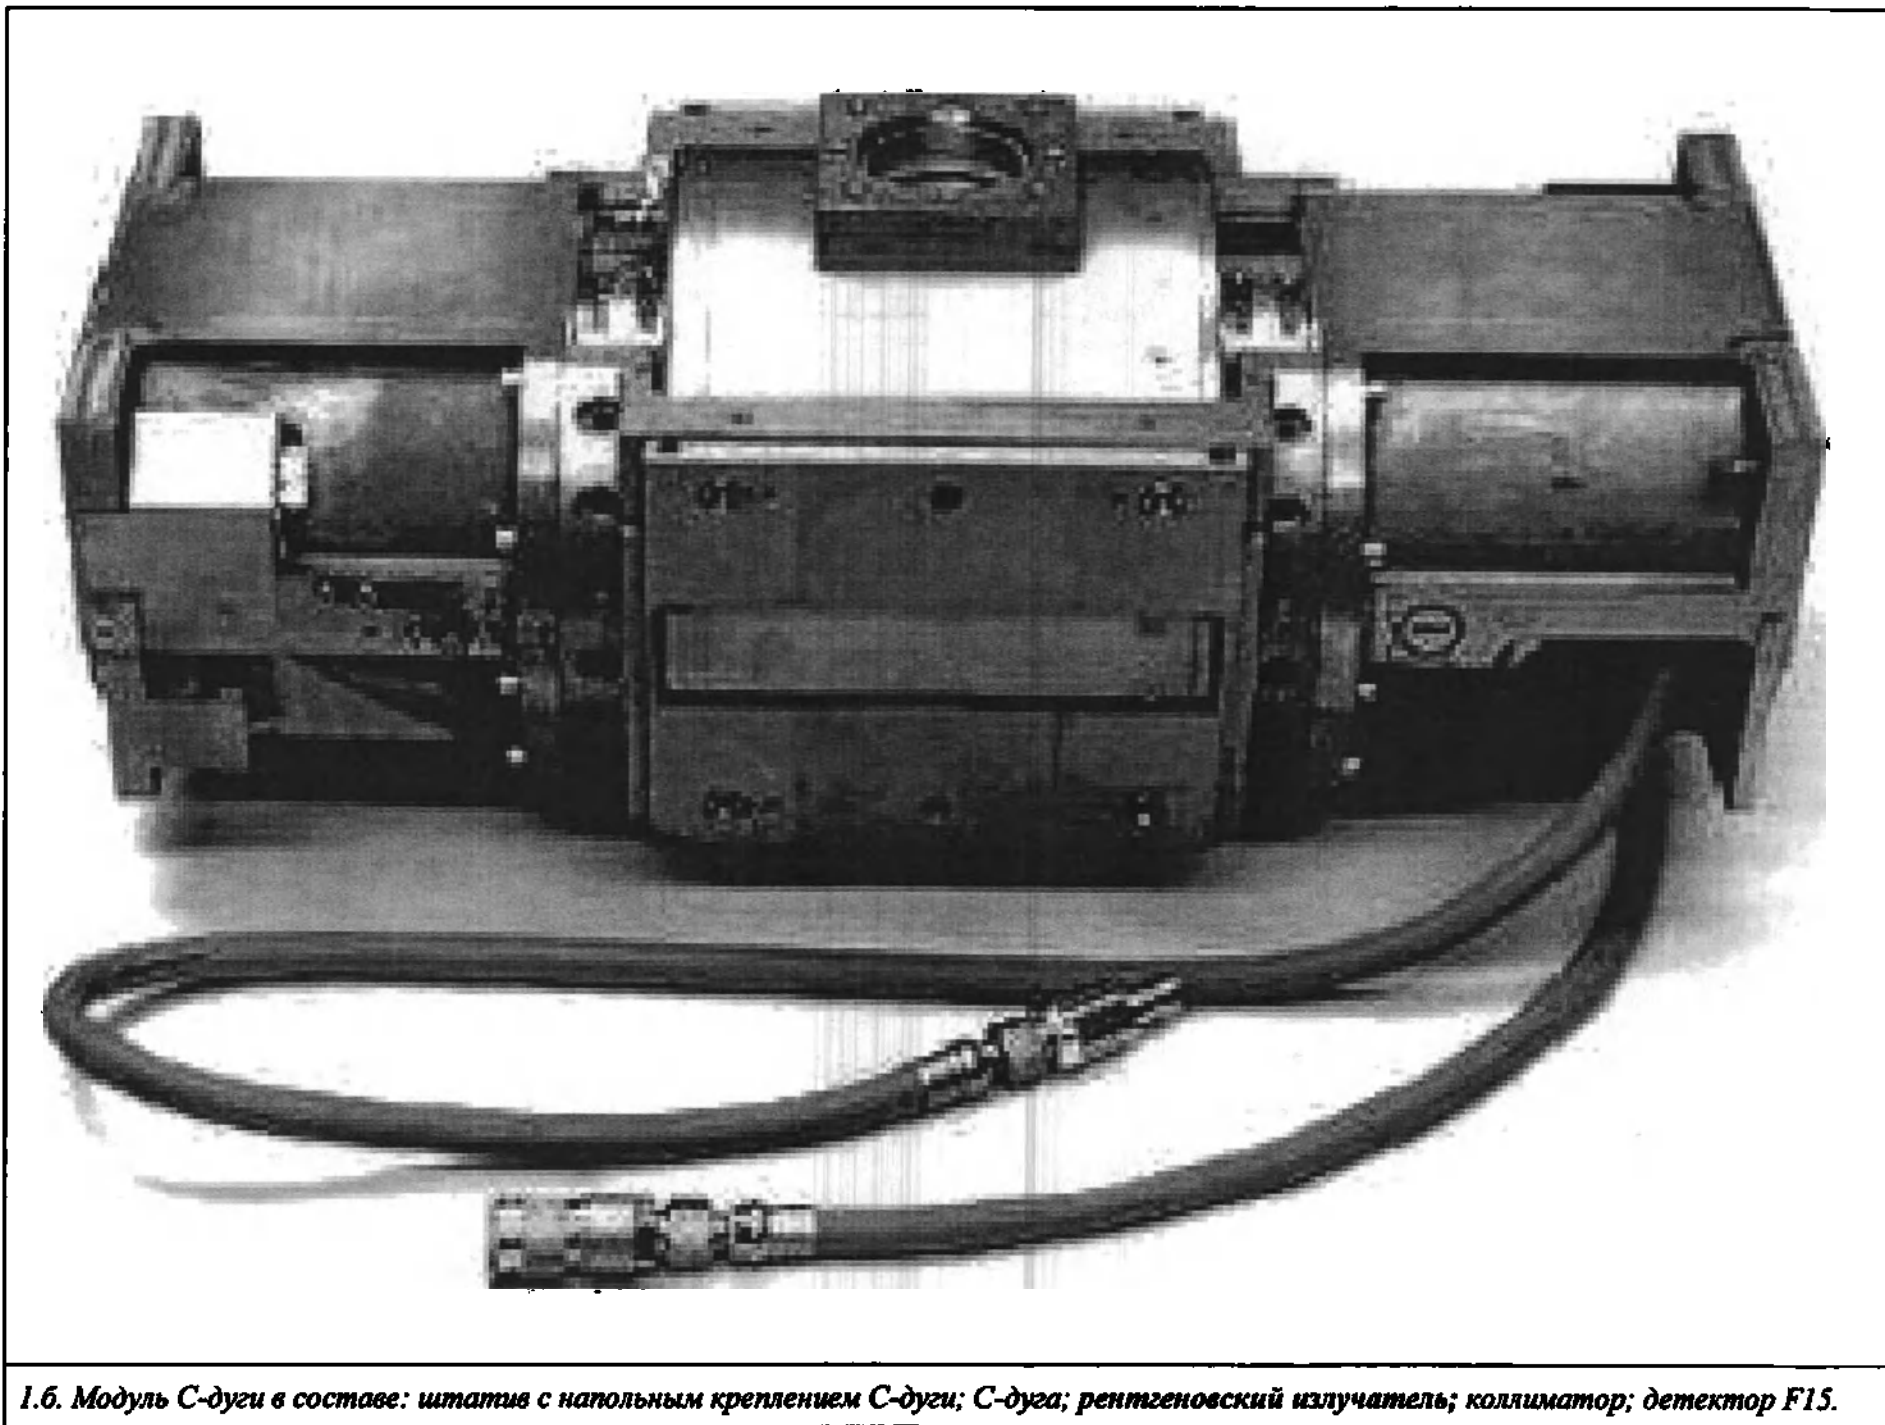


1.6. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F15.

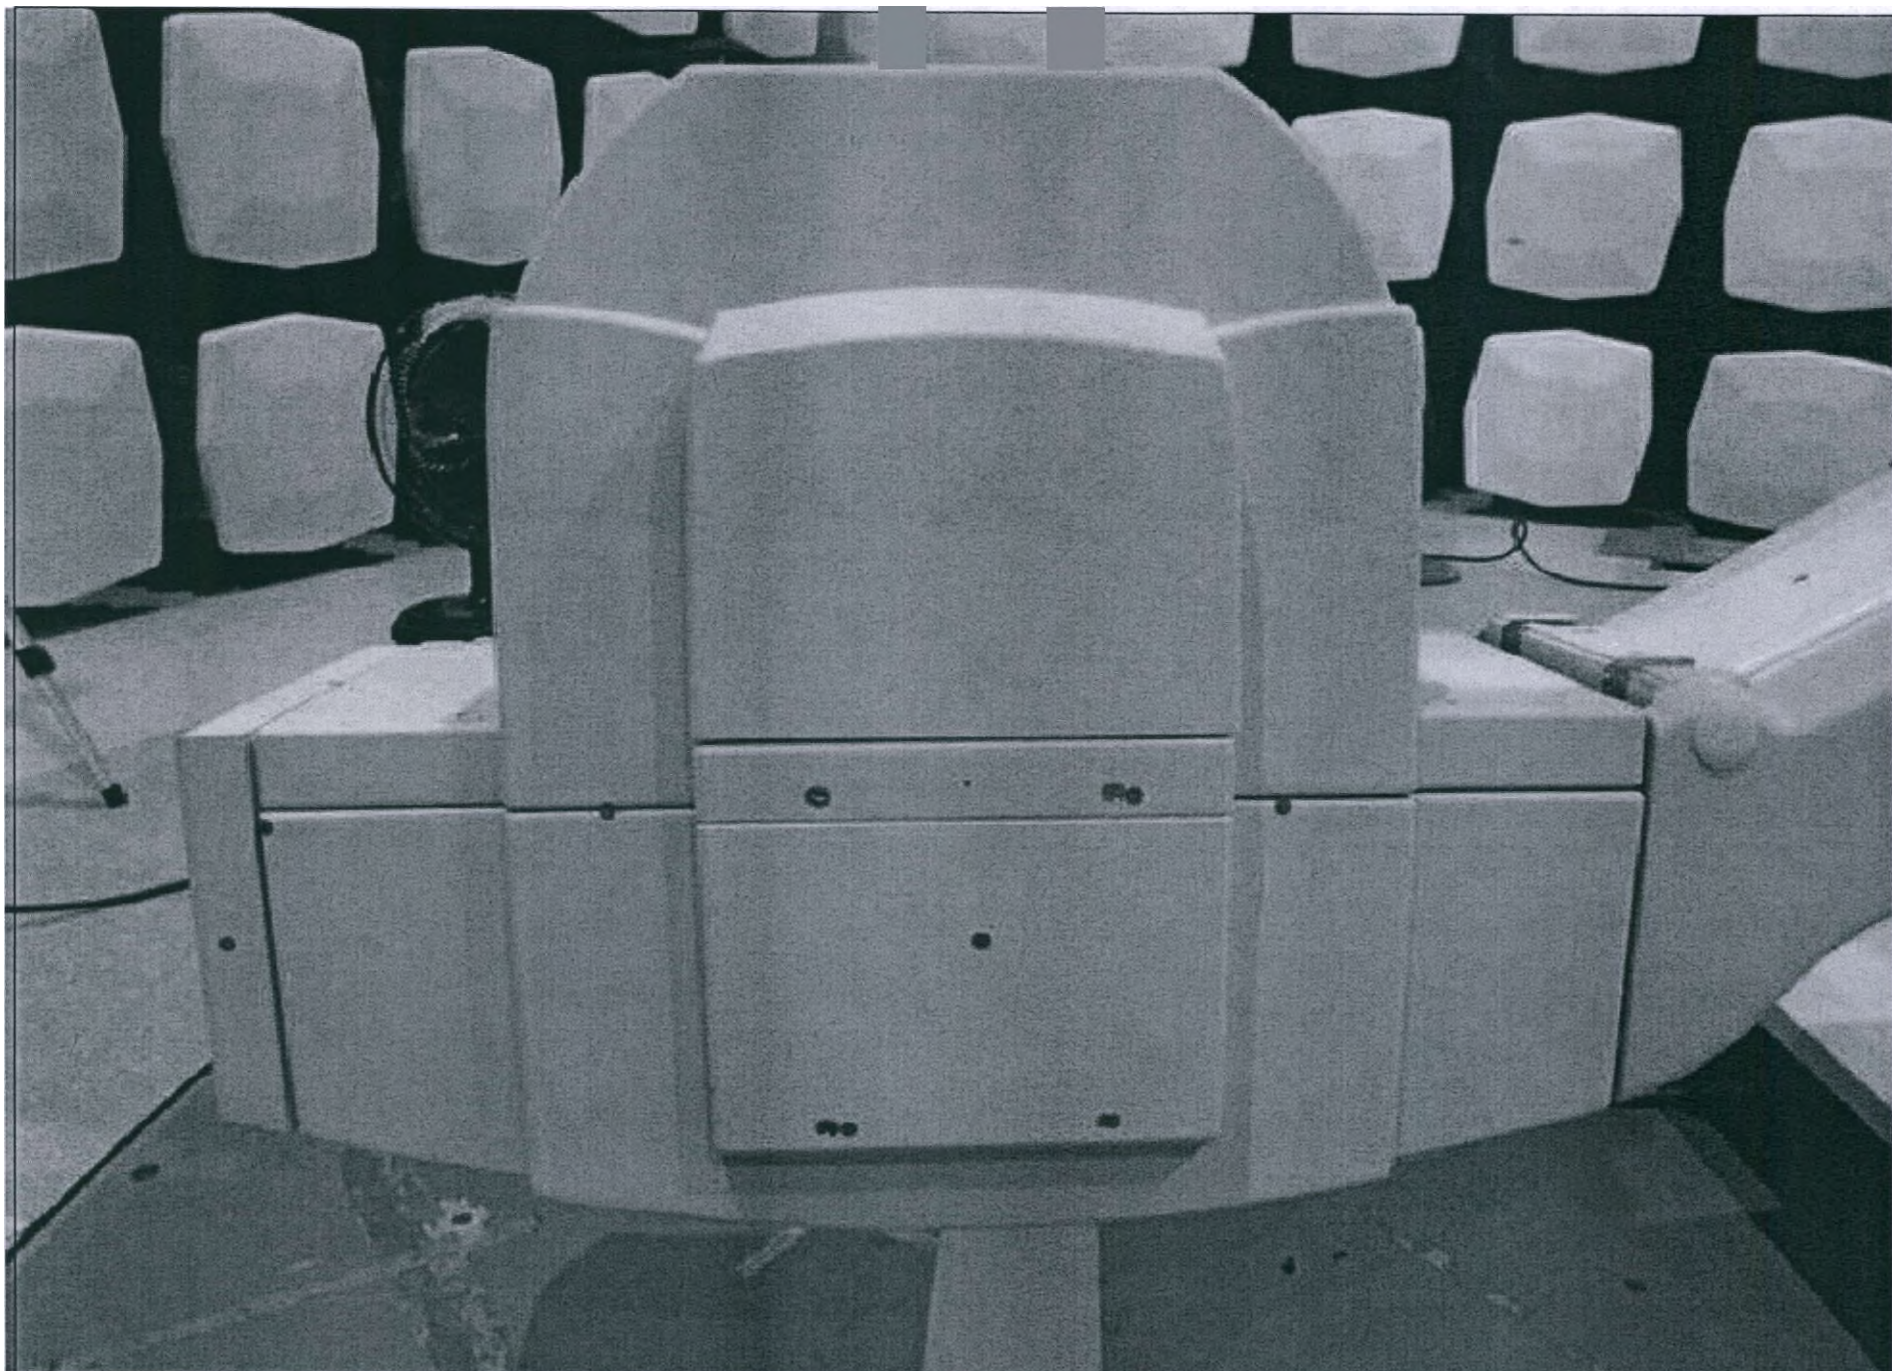


1.в. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F15.

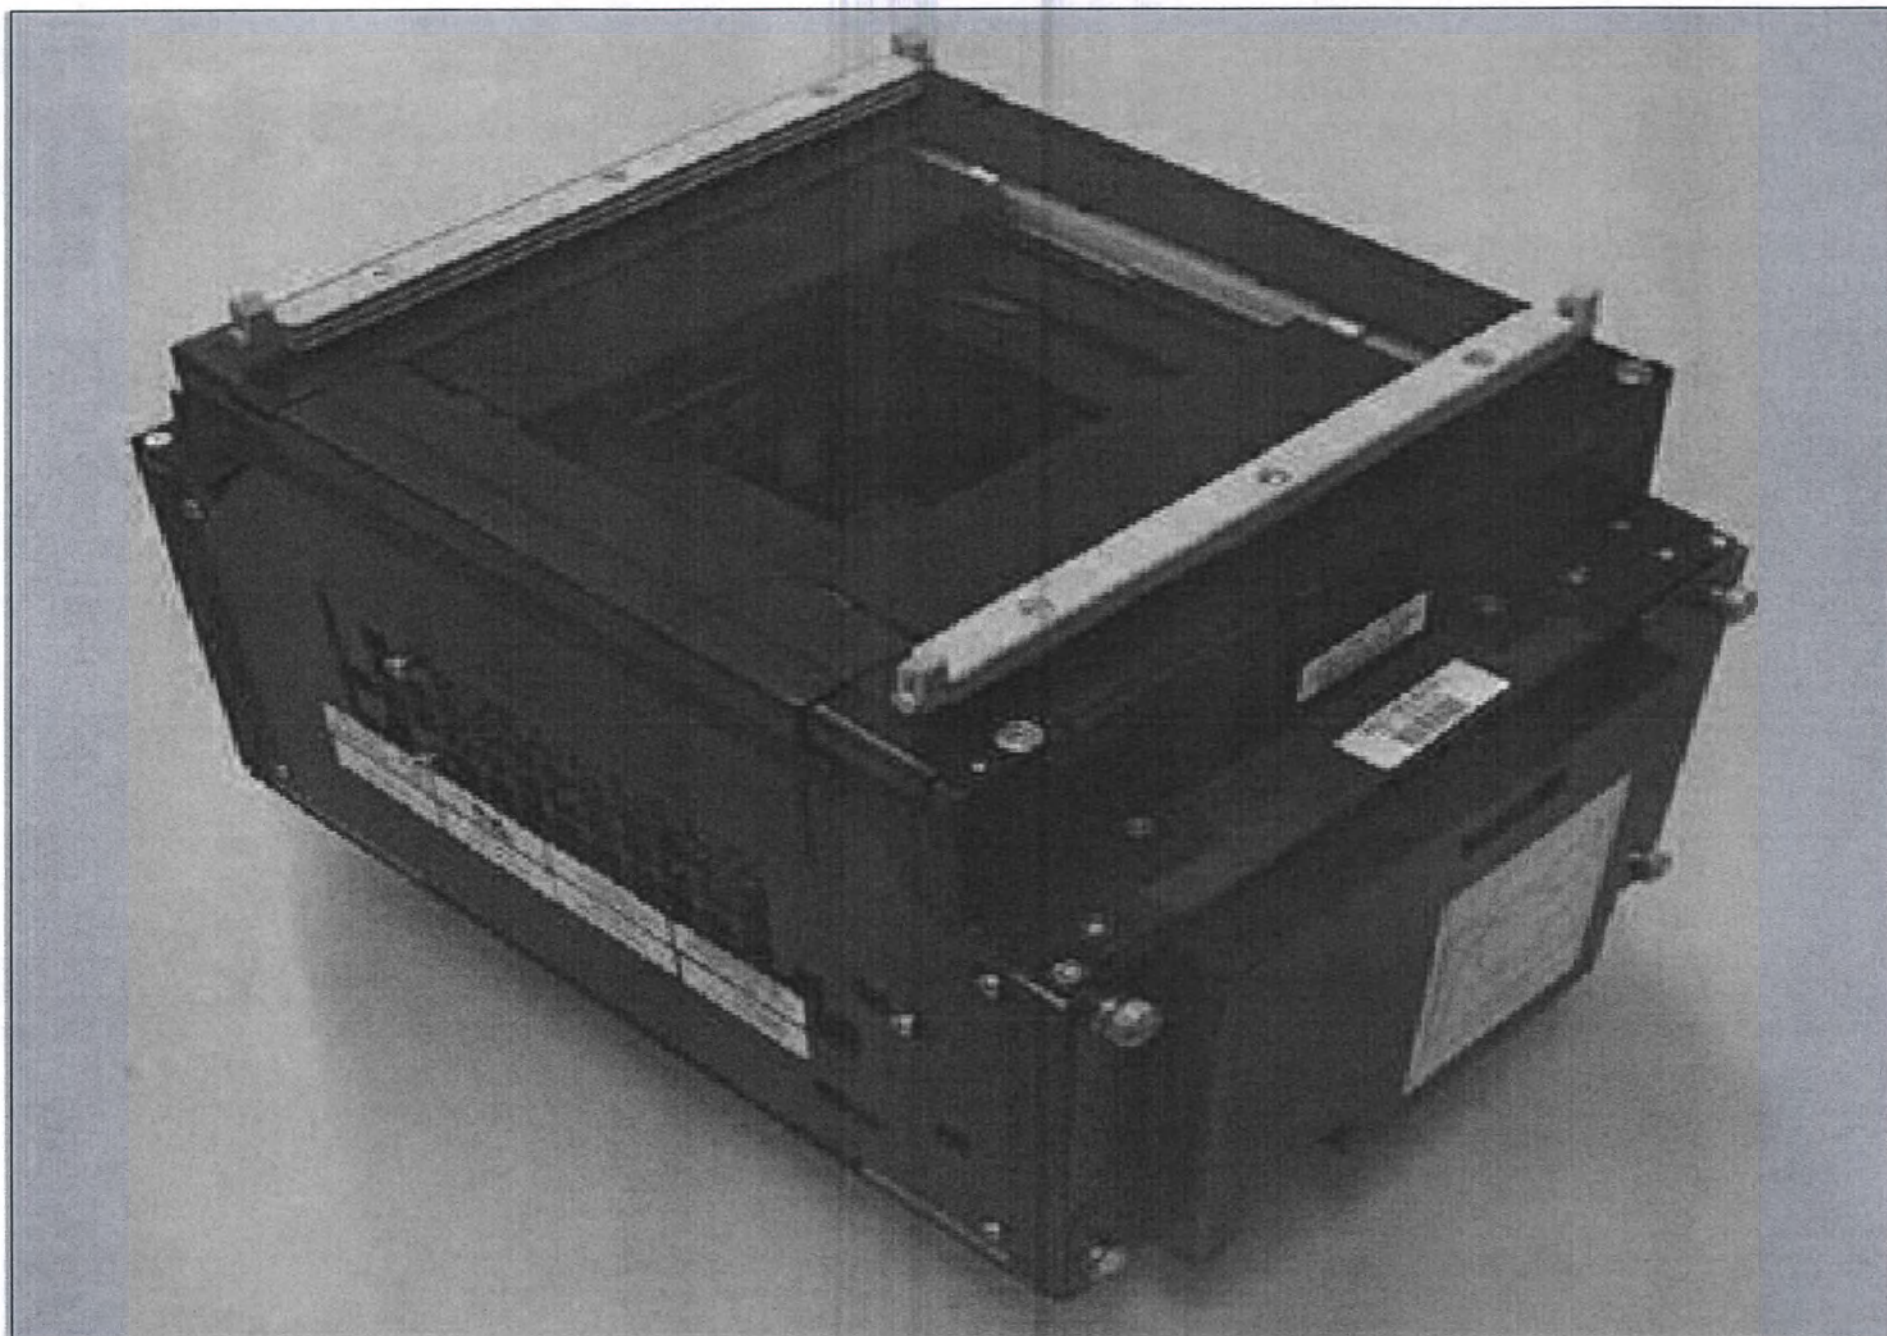


1.2. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F15.

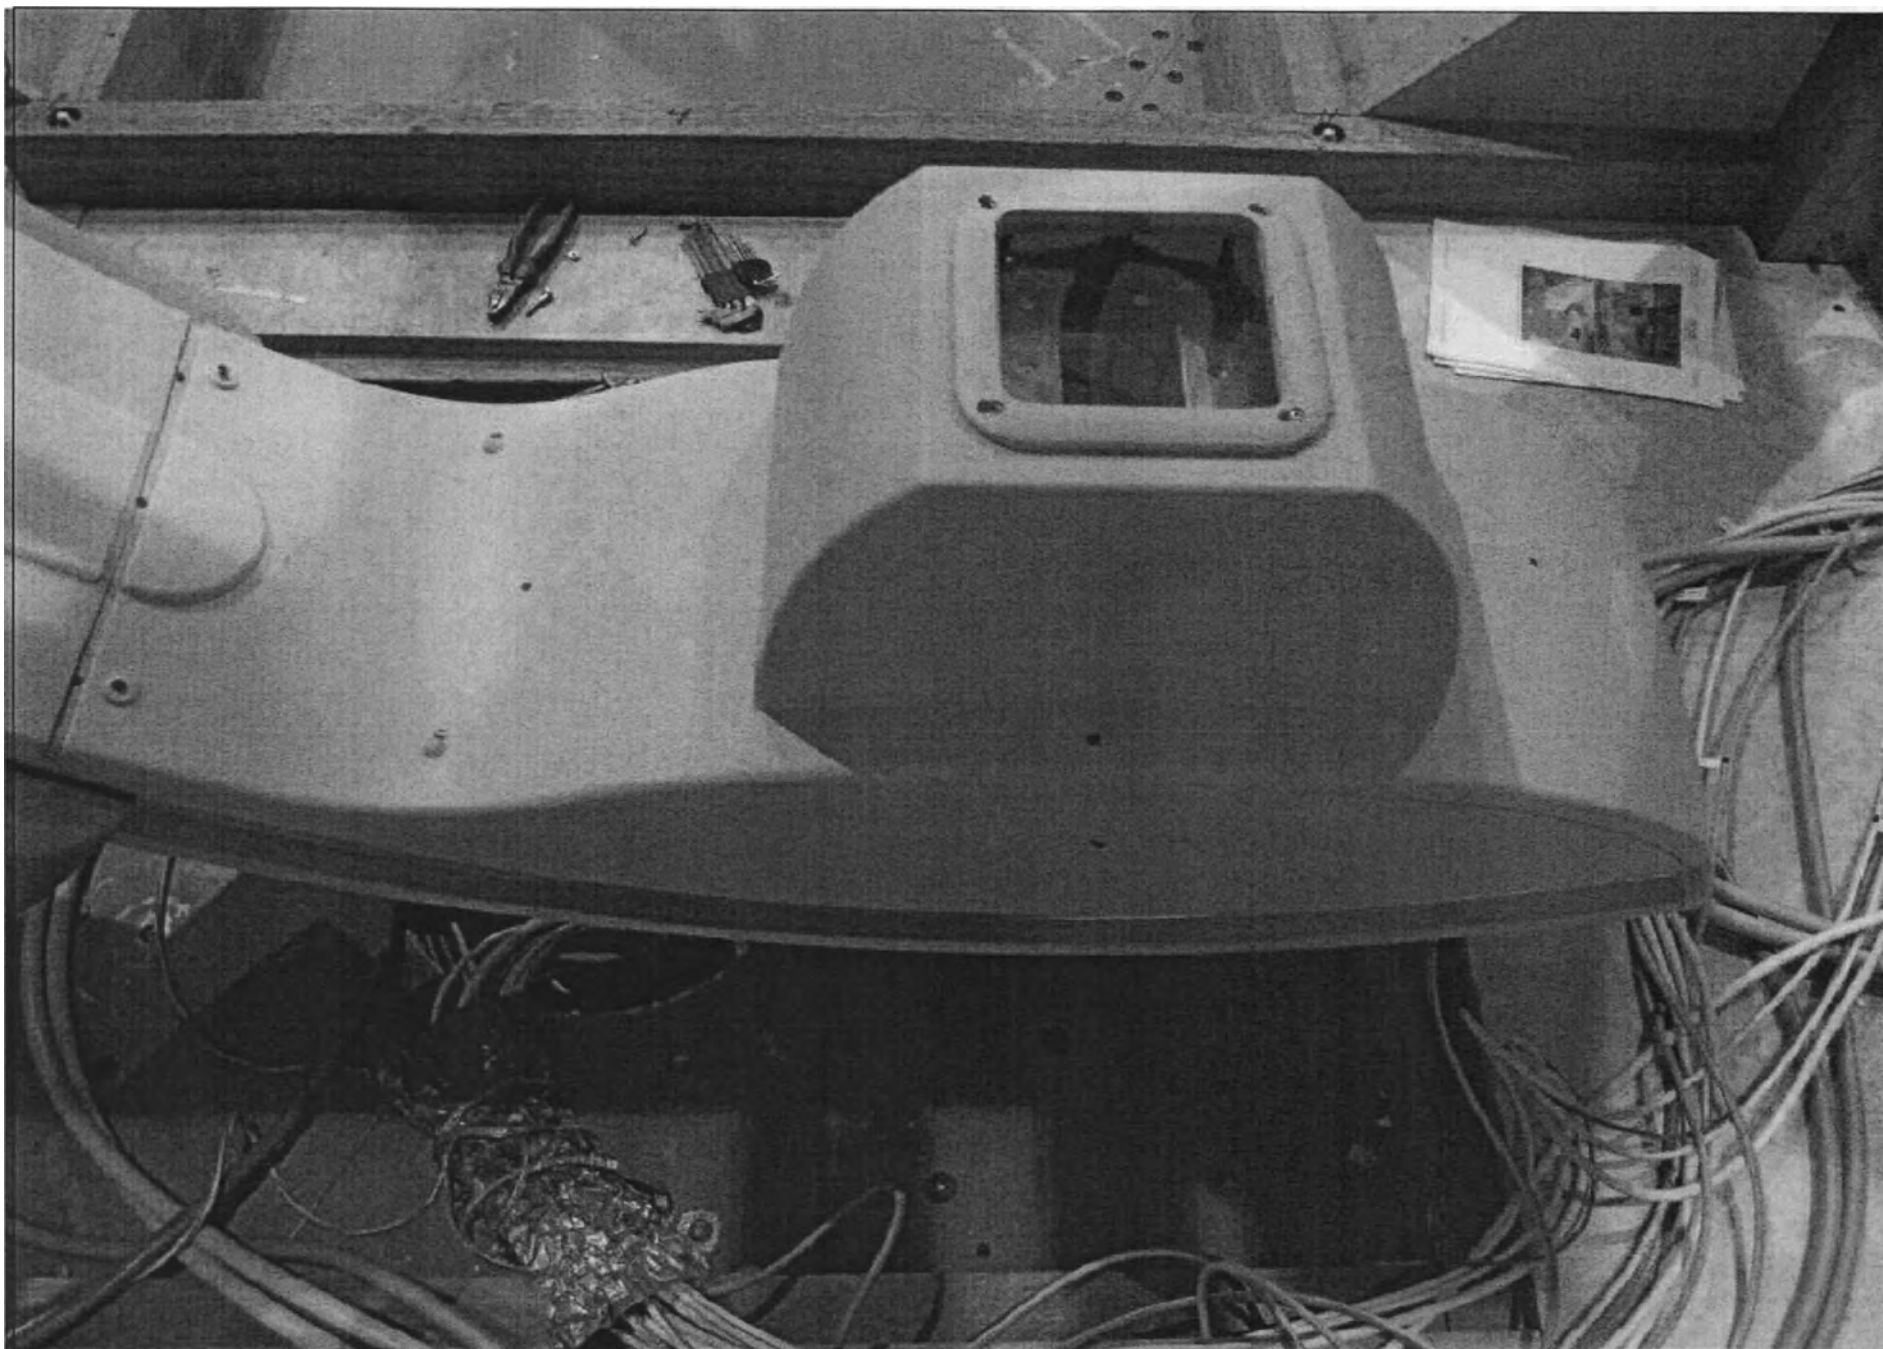


1.д. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F15.

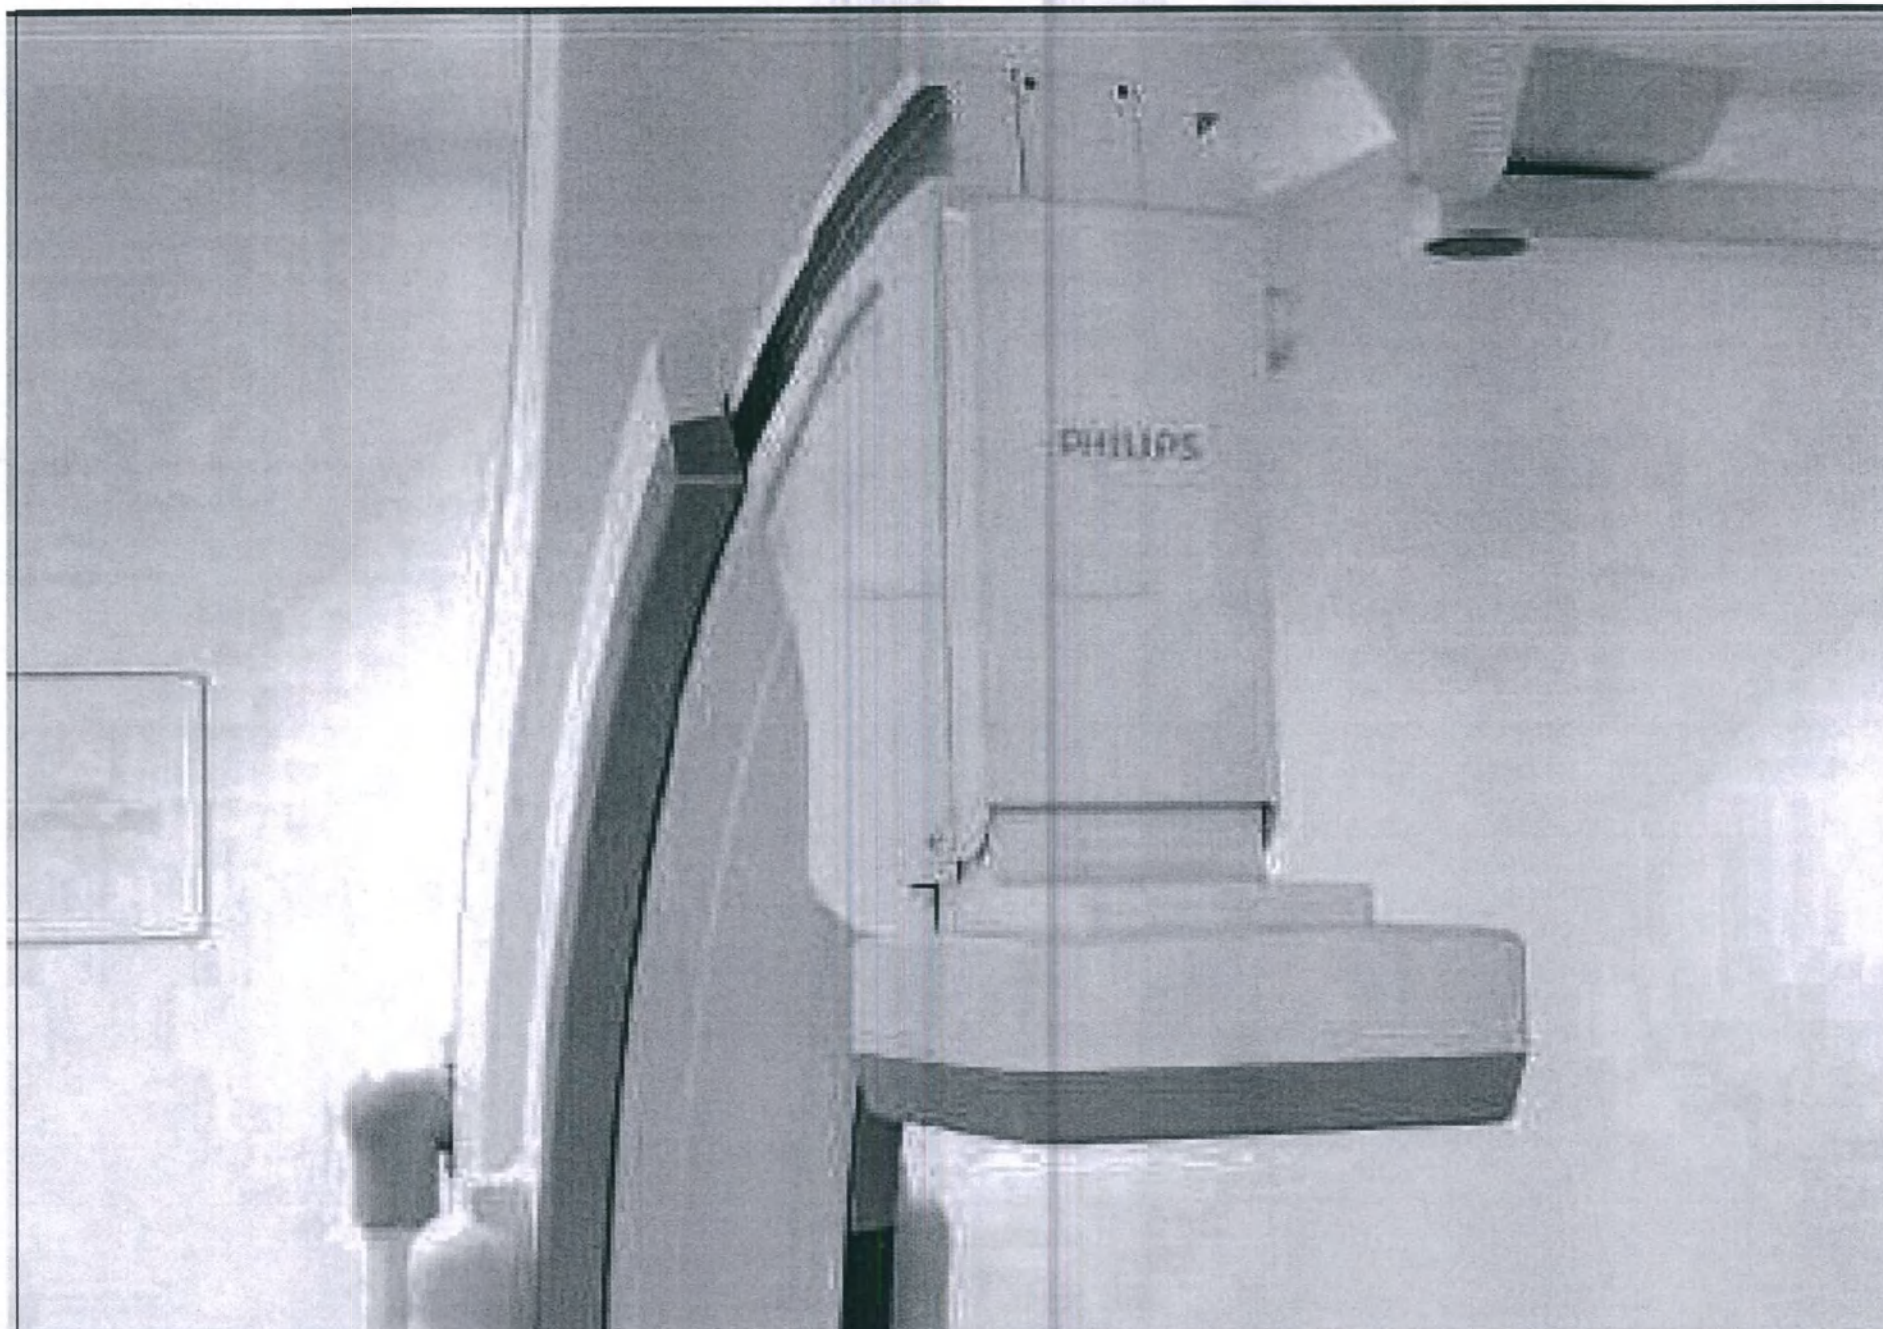


1.е. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F15.

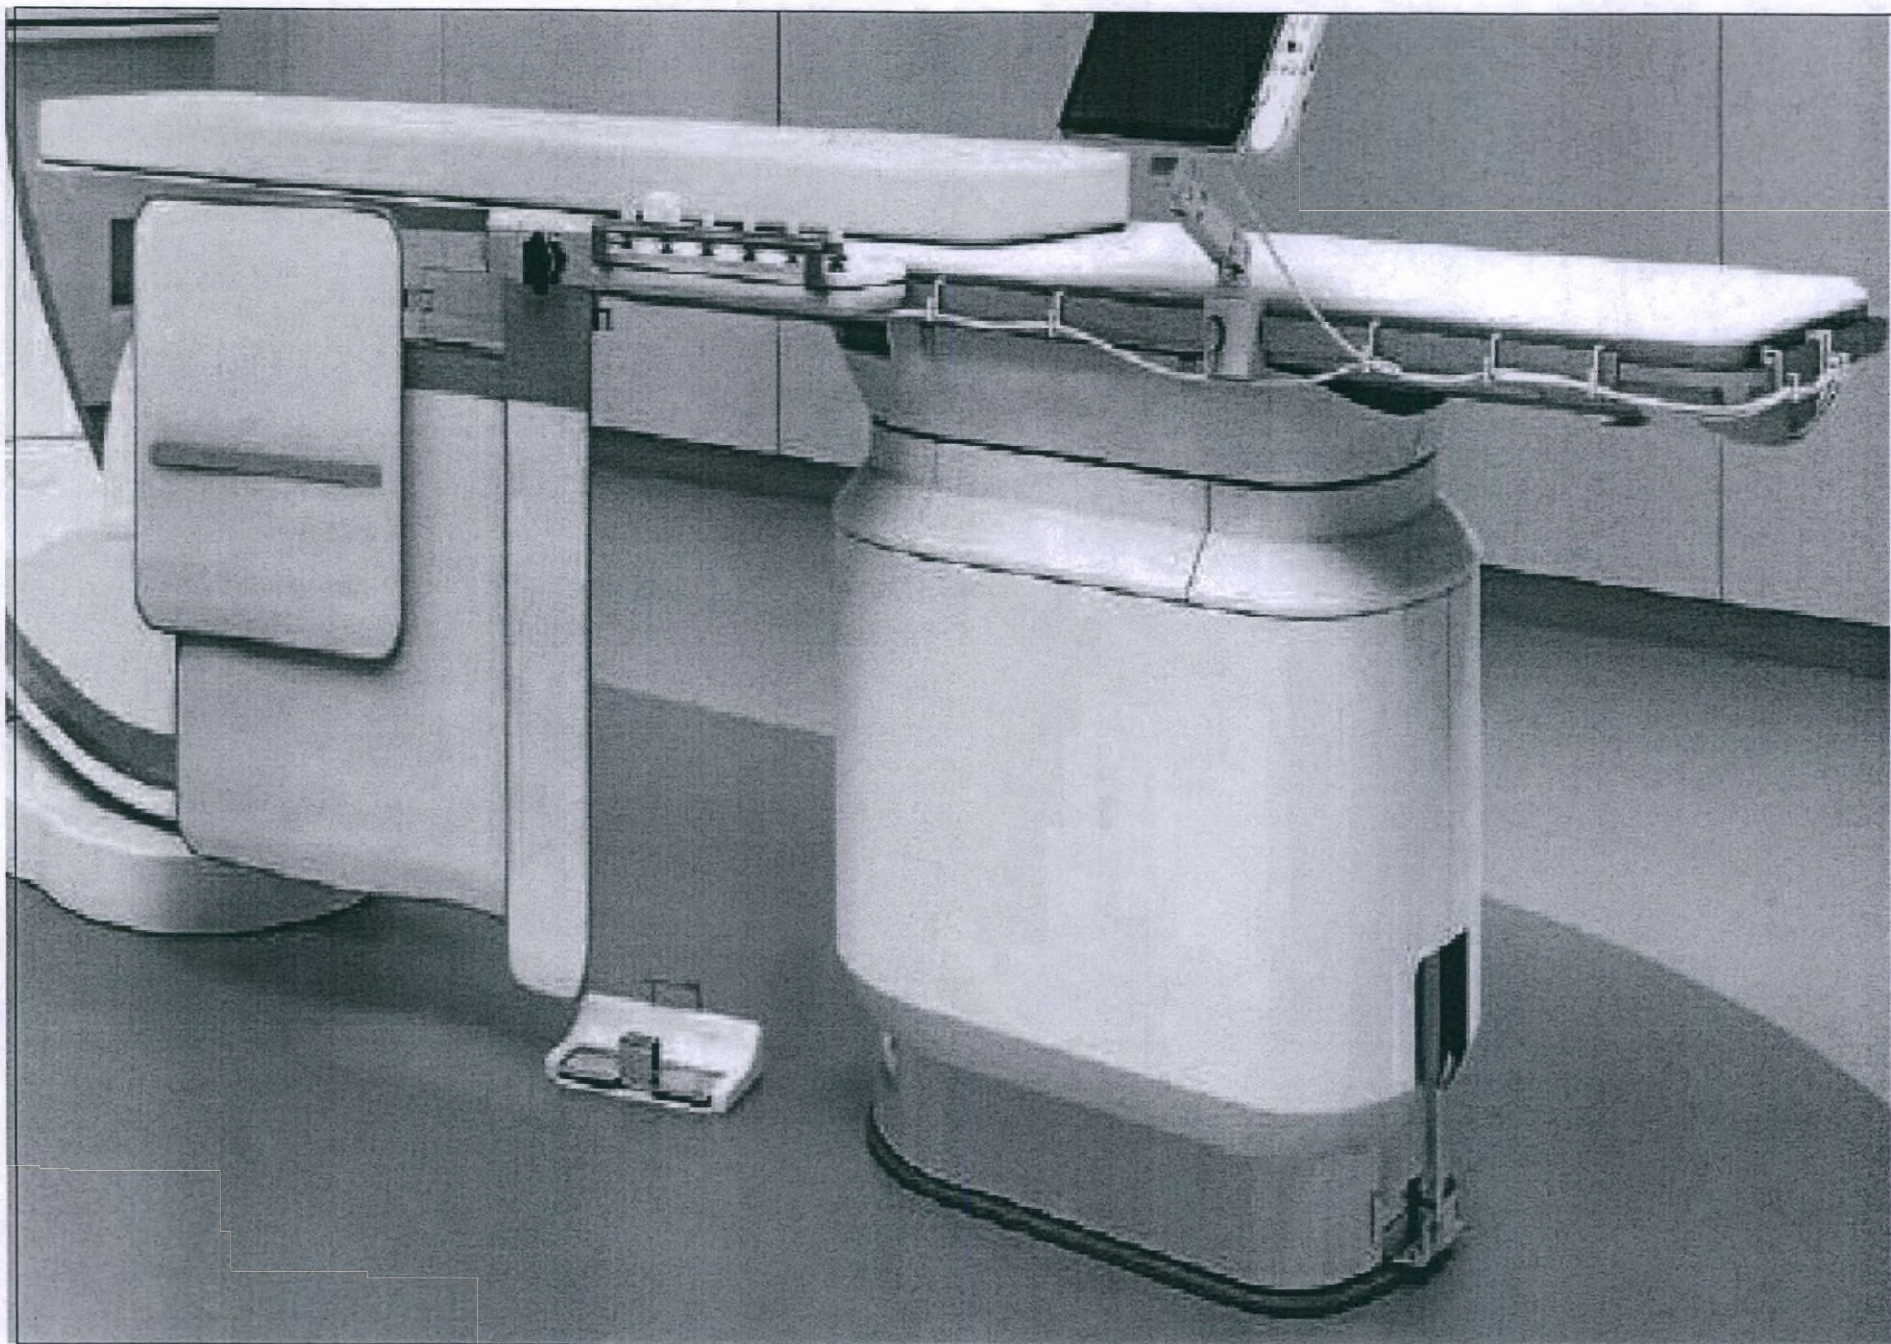


2.а. Стол пациента, варианты исполнения: *Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.*

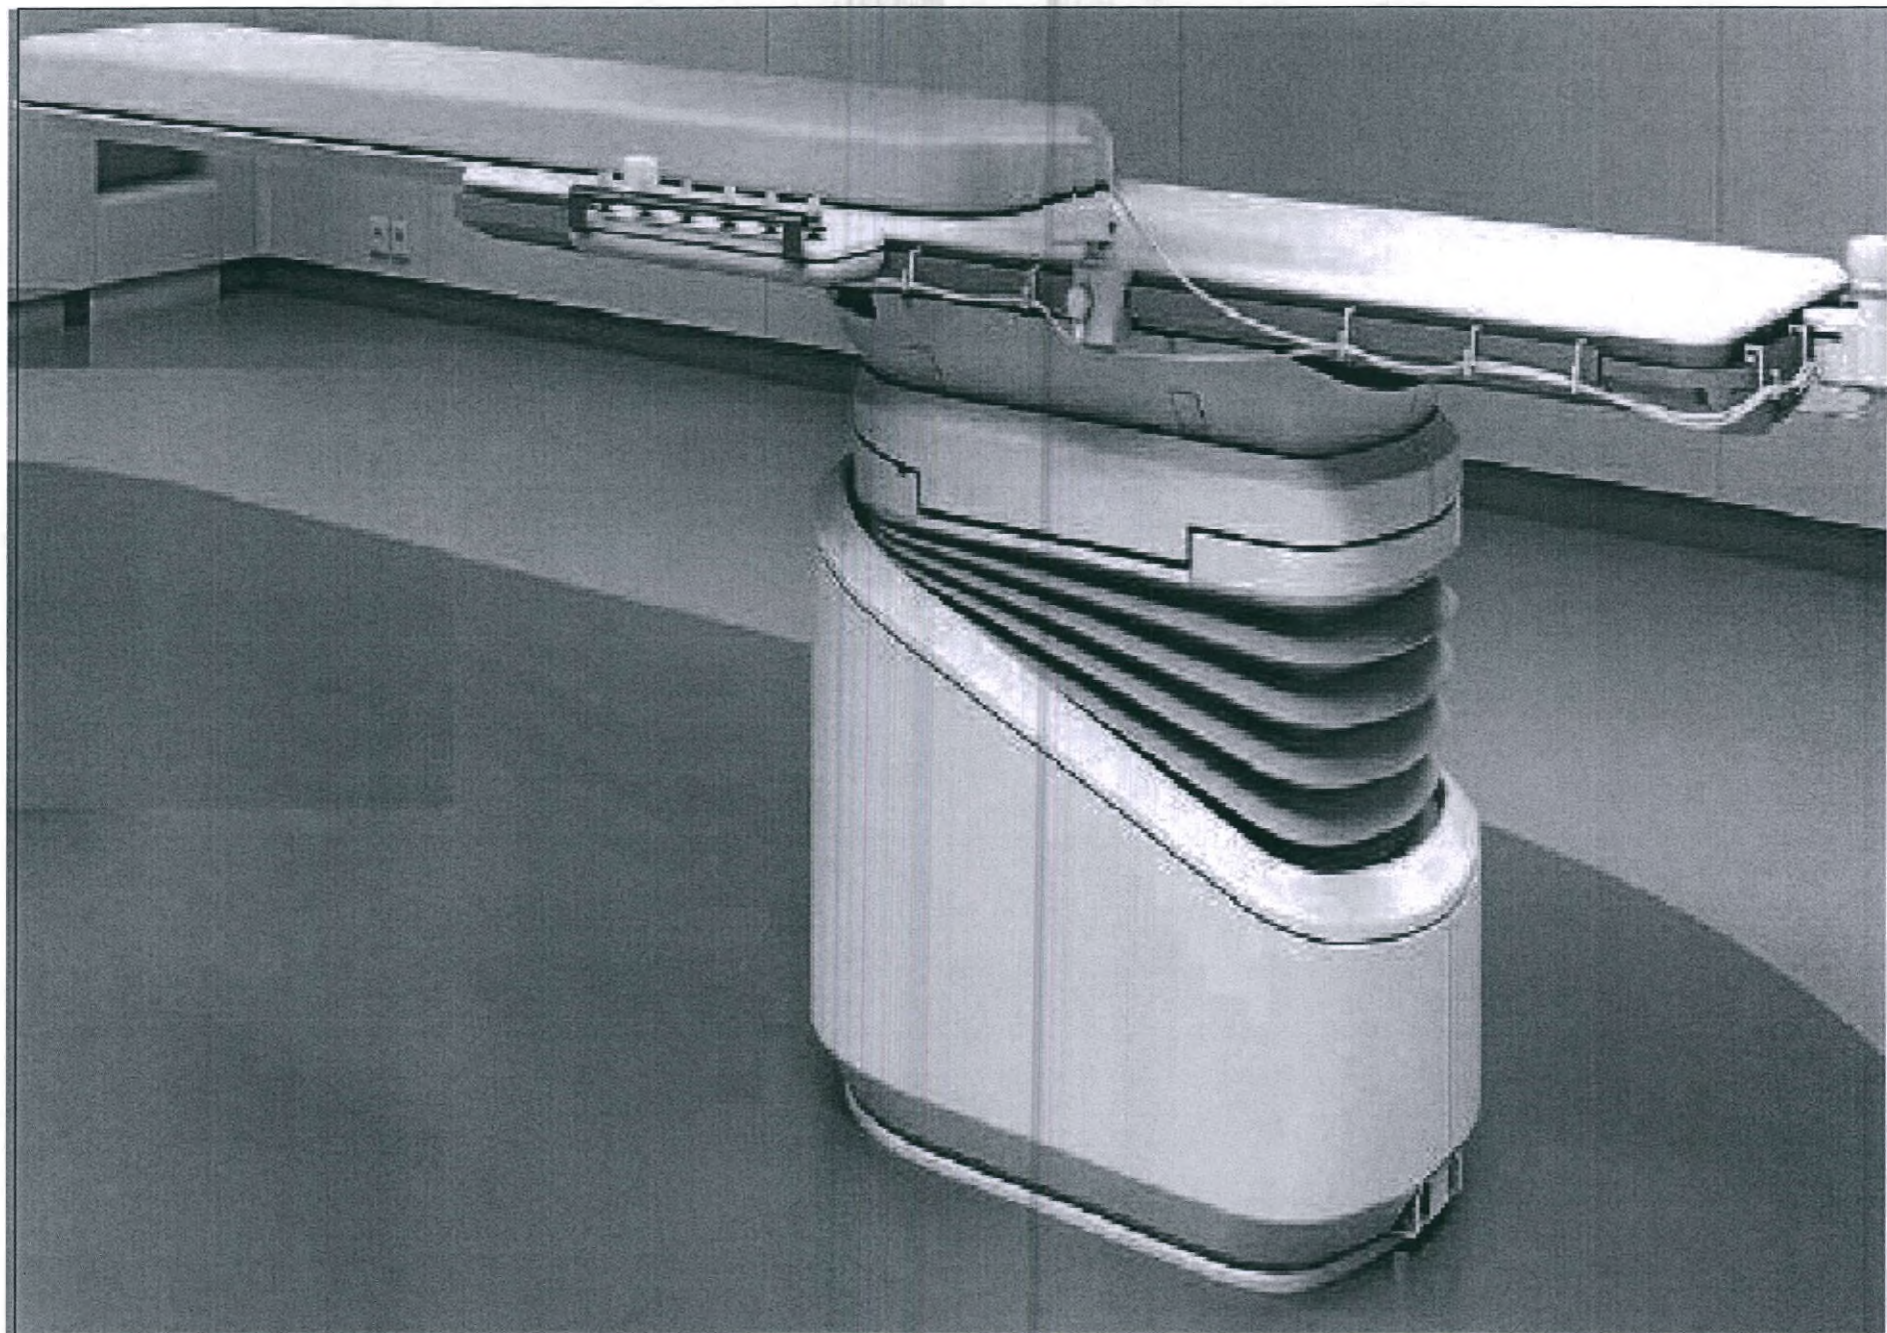


2.б. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

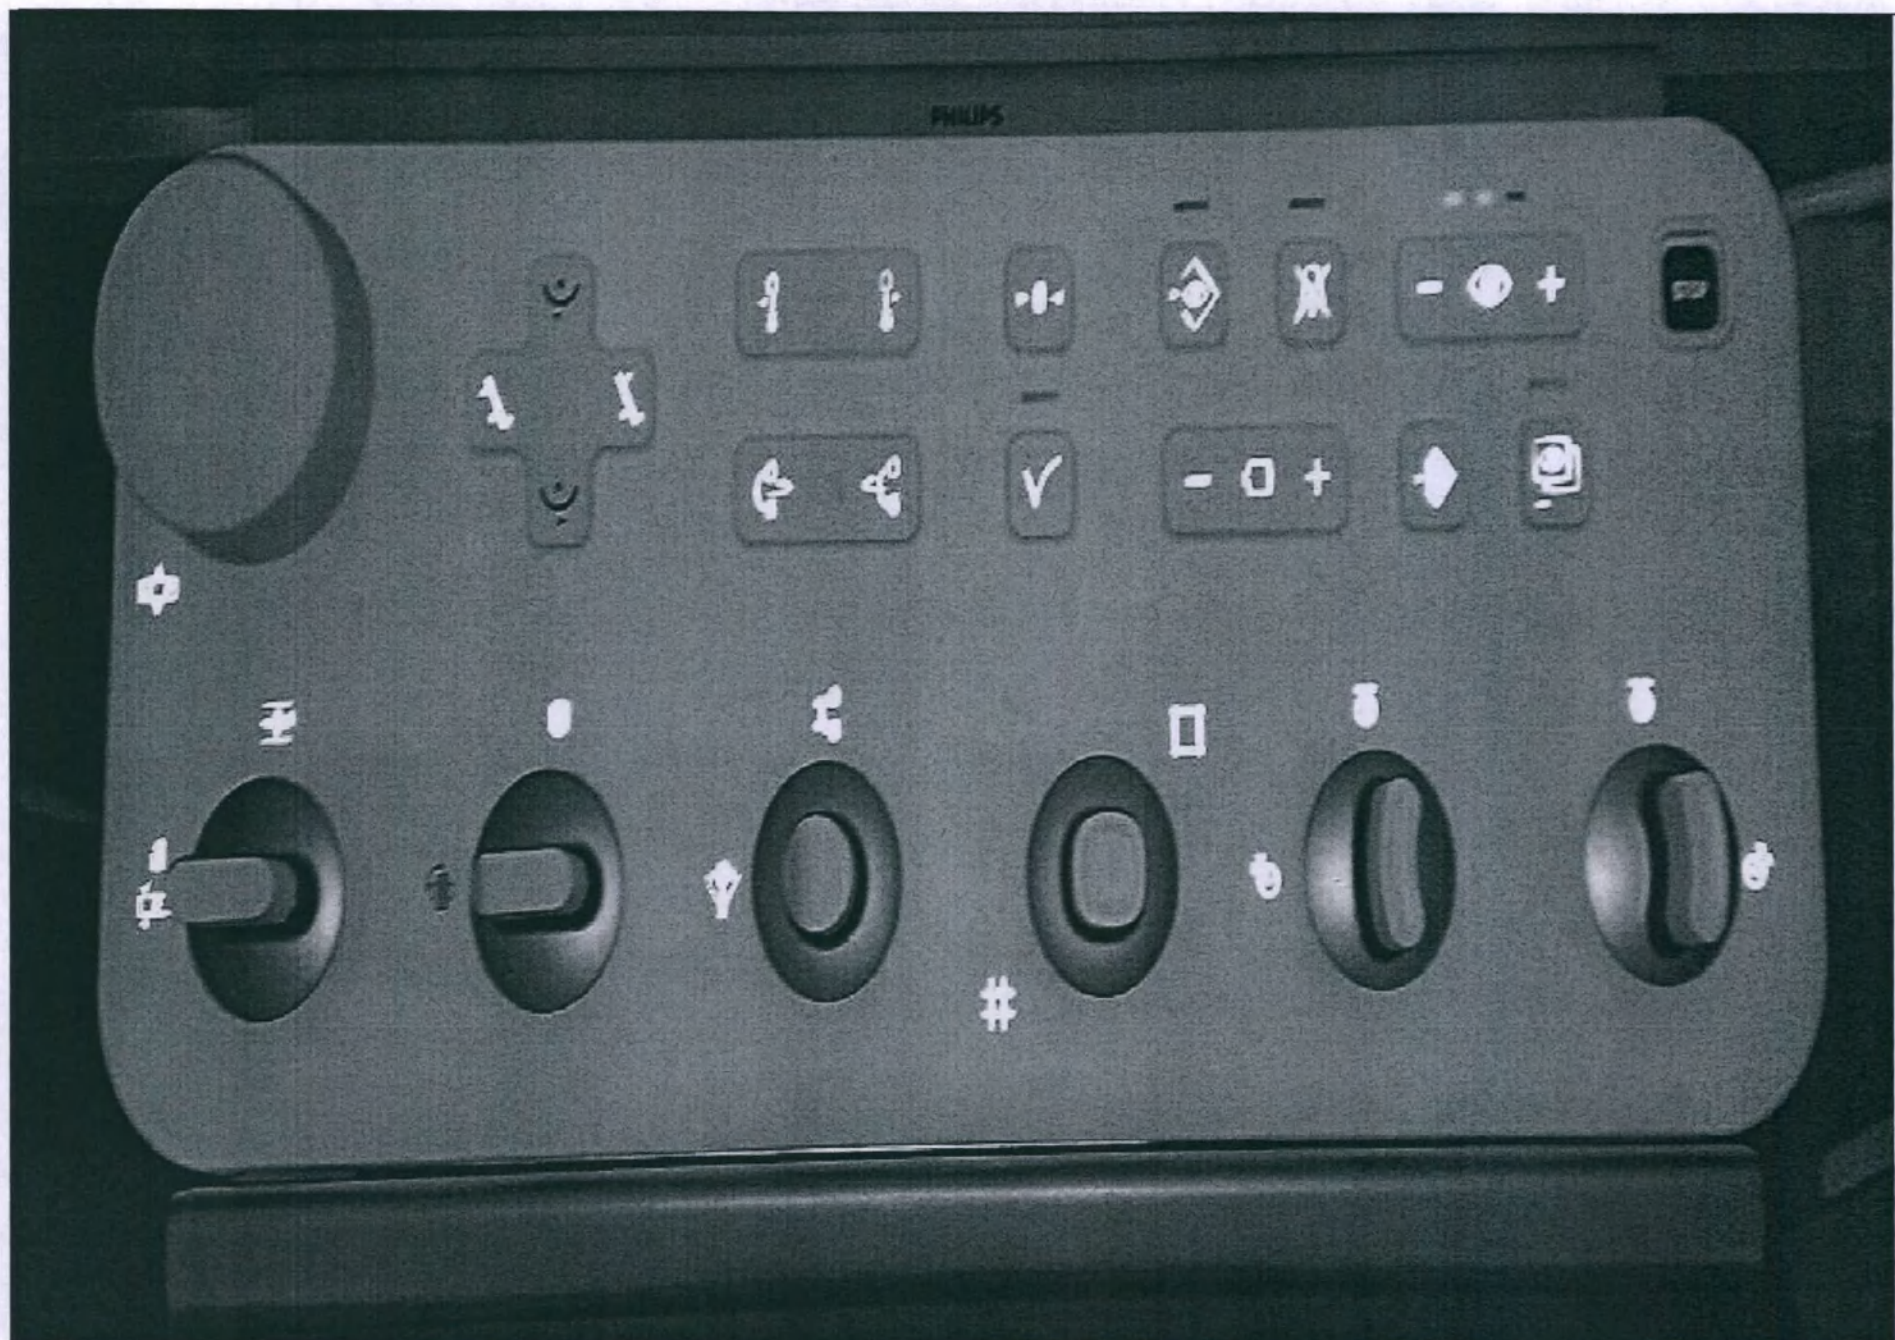


3. Модуль управления, не более 4 шт.

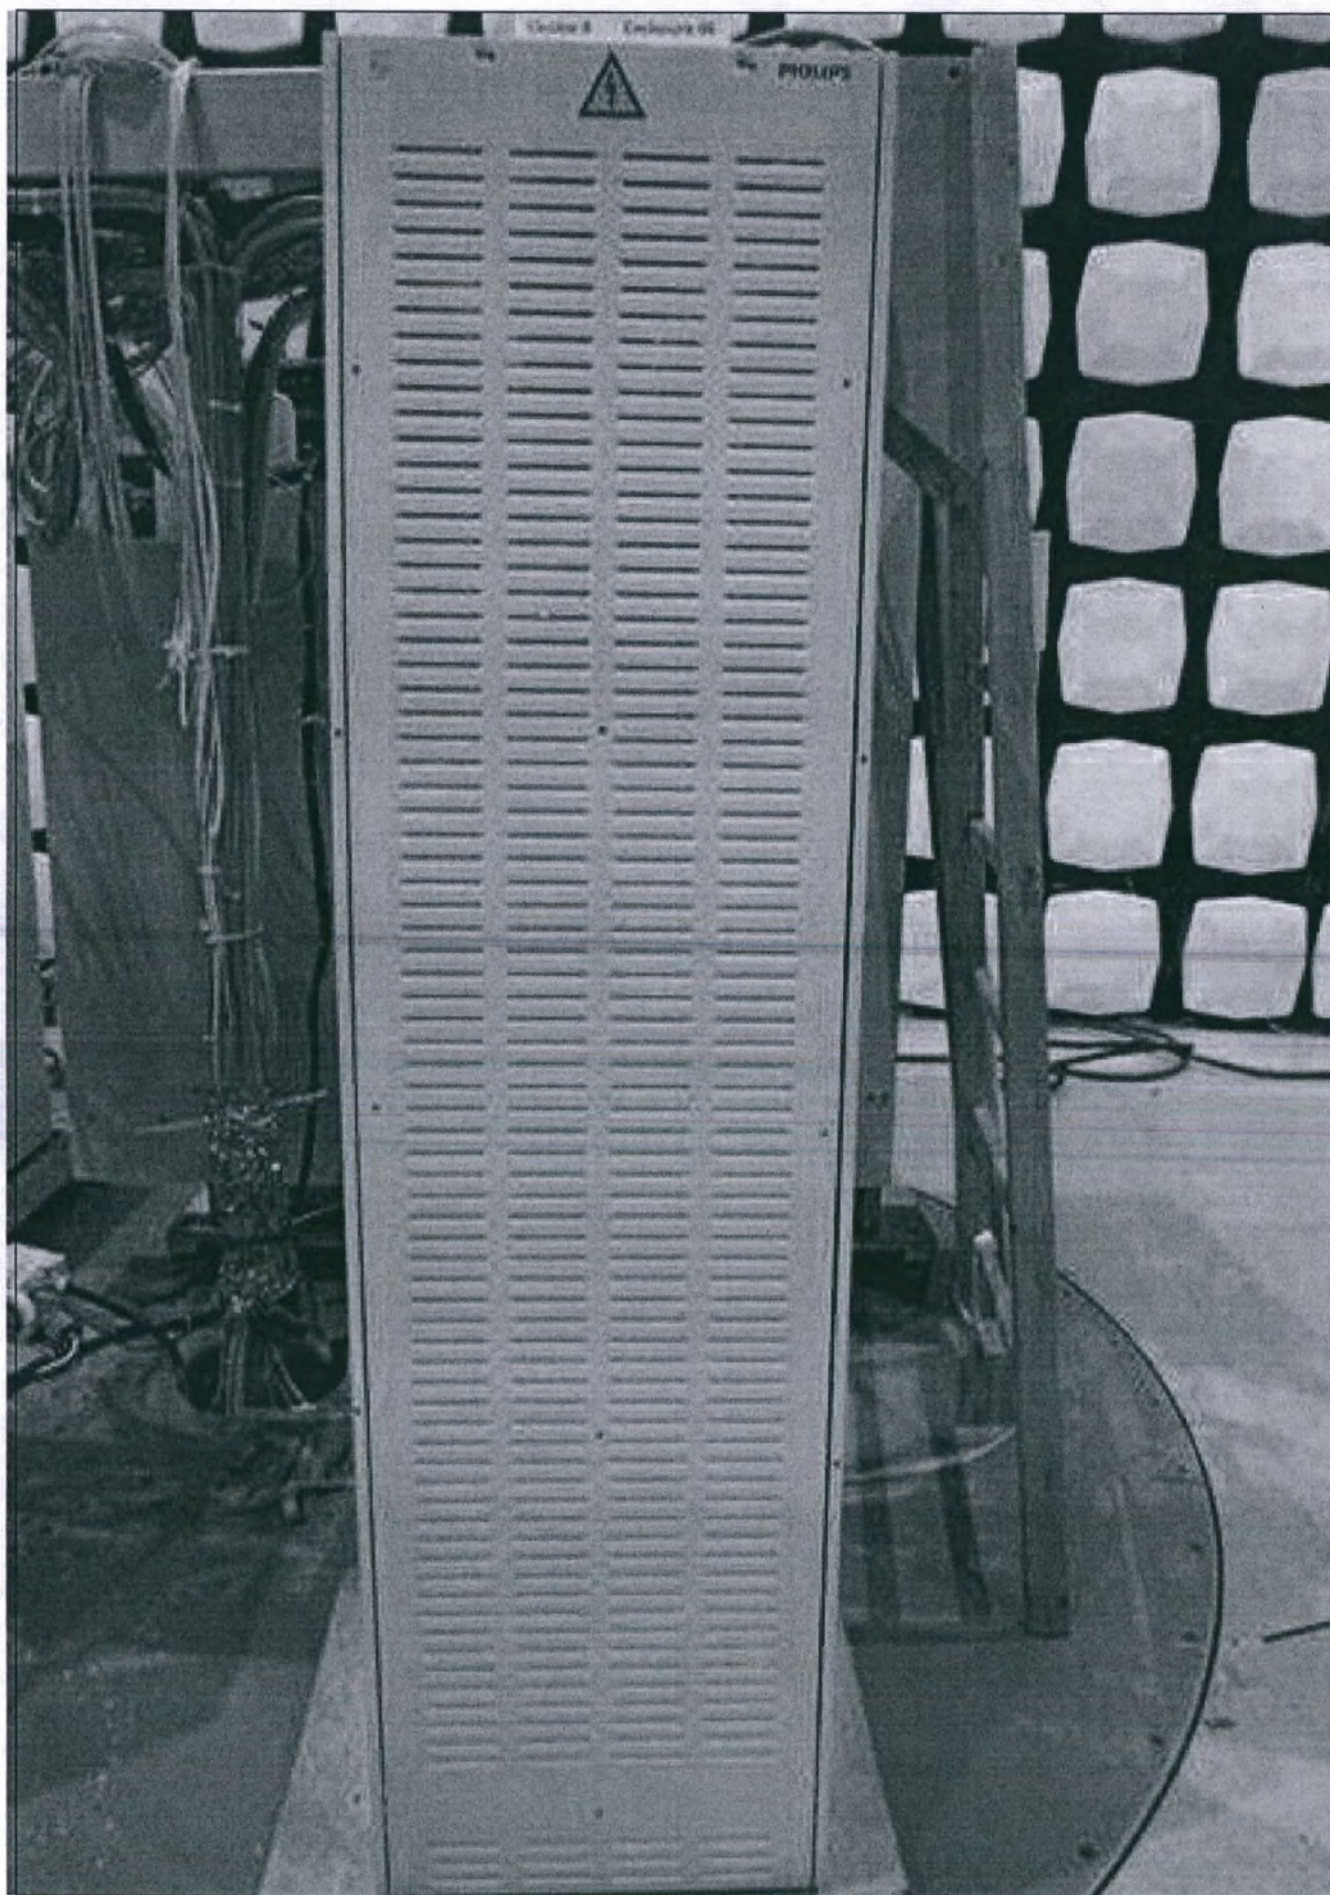


4.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

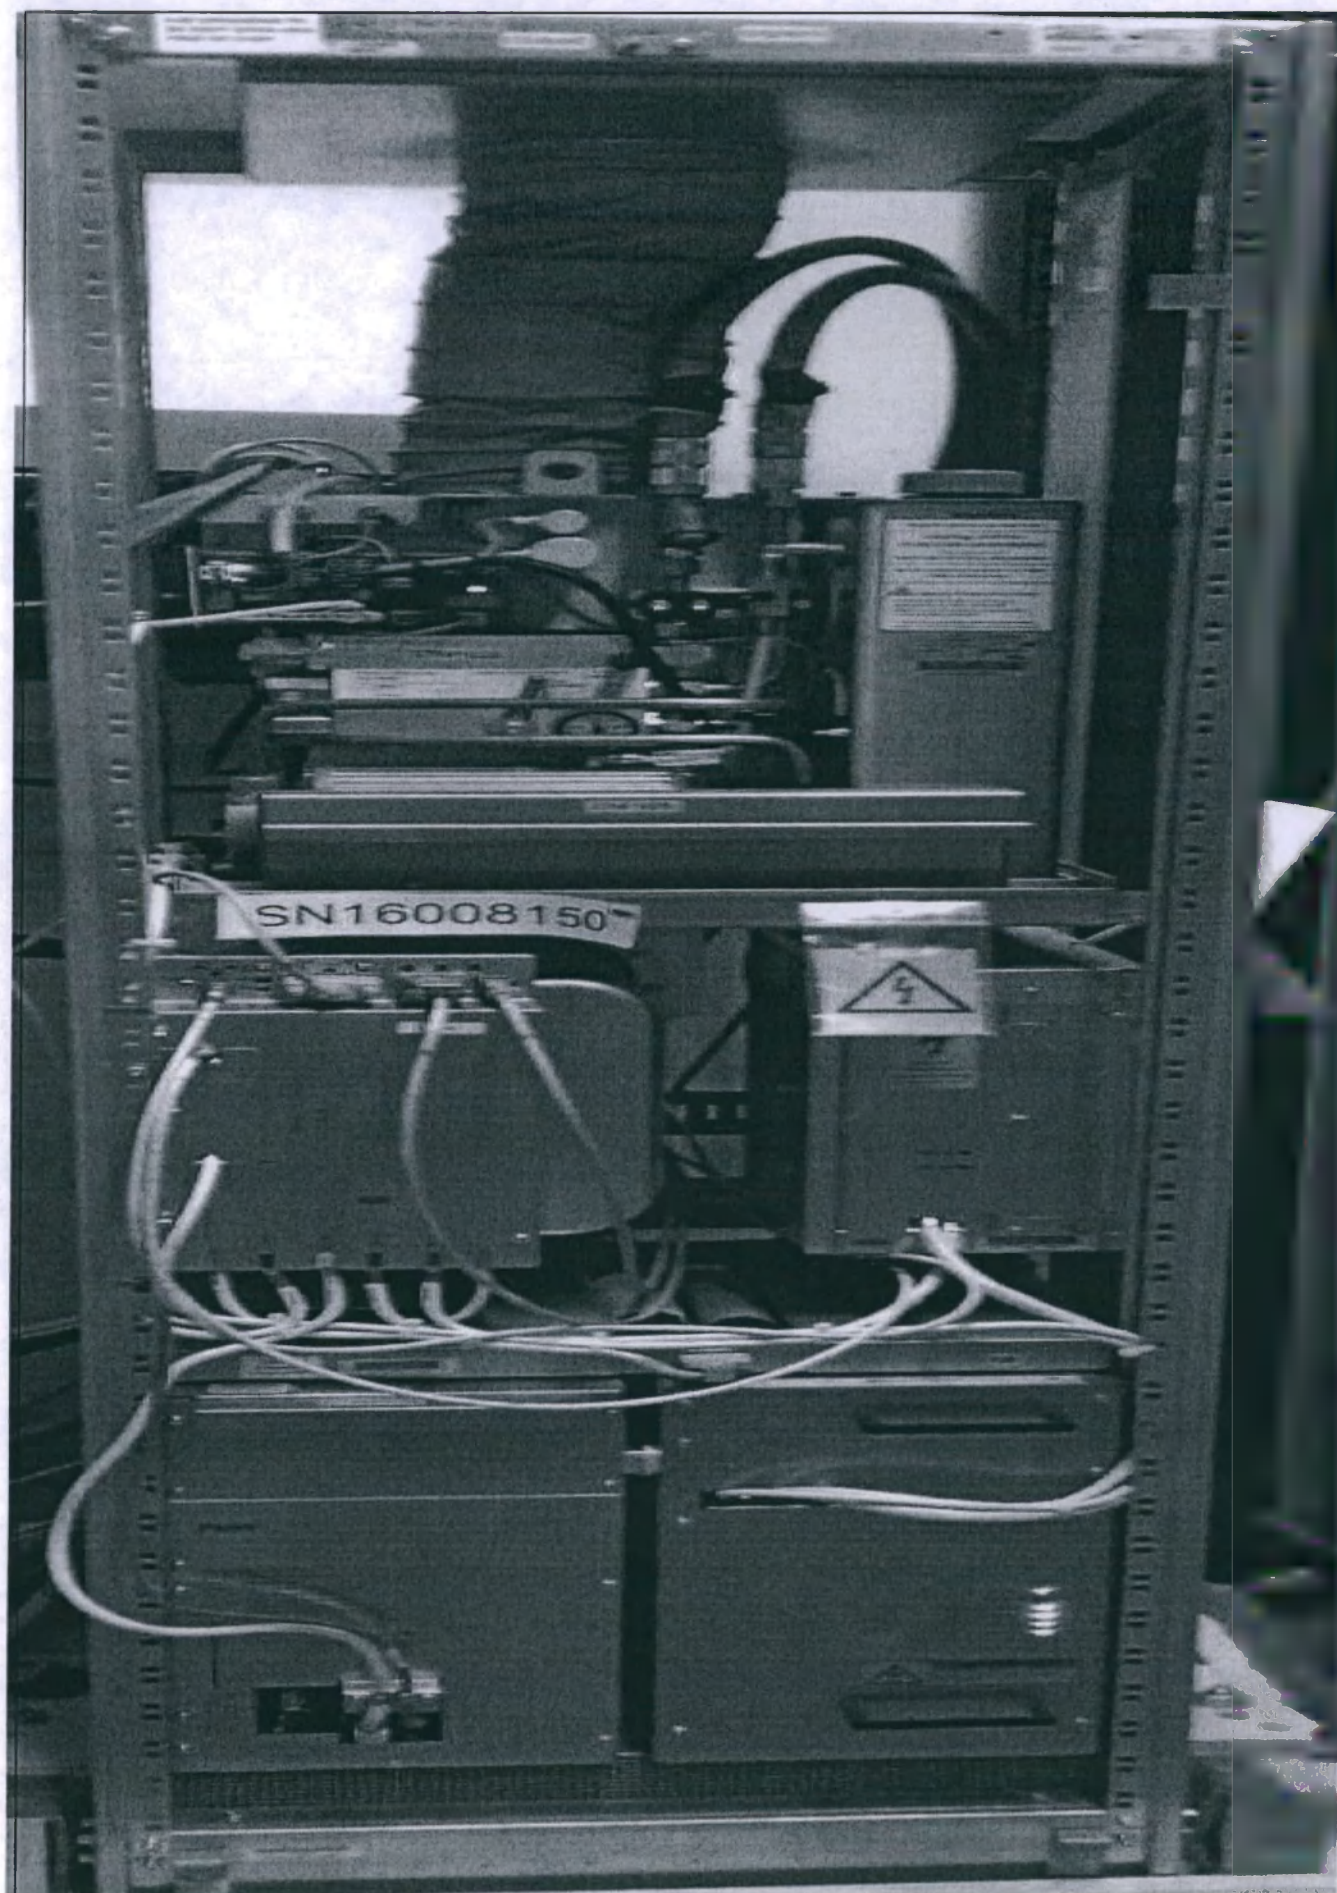


4.6. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

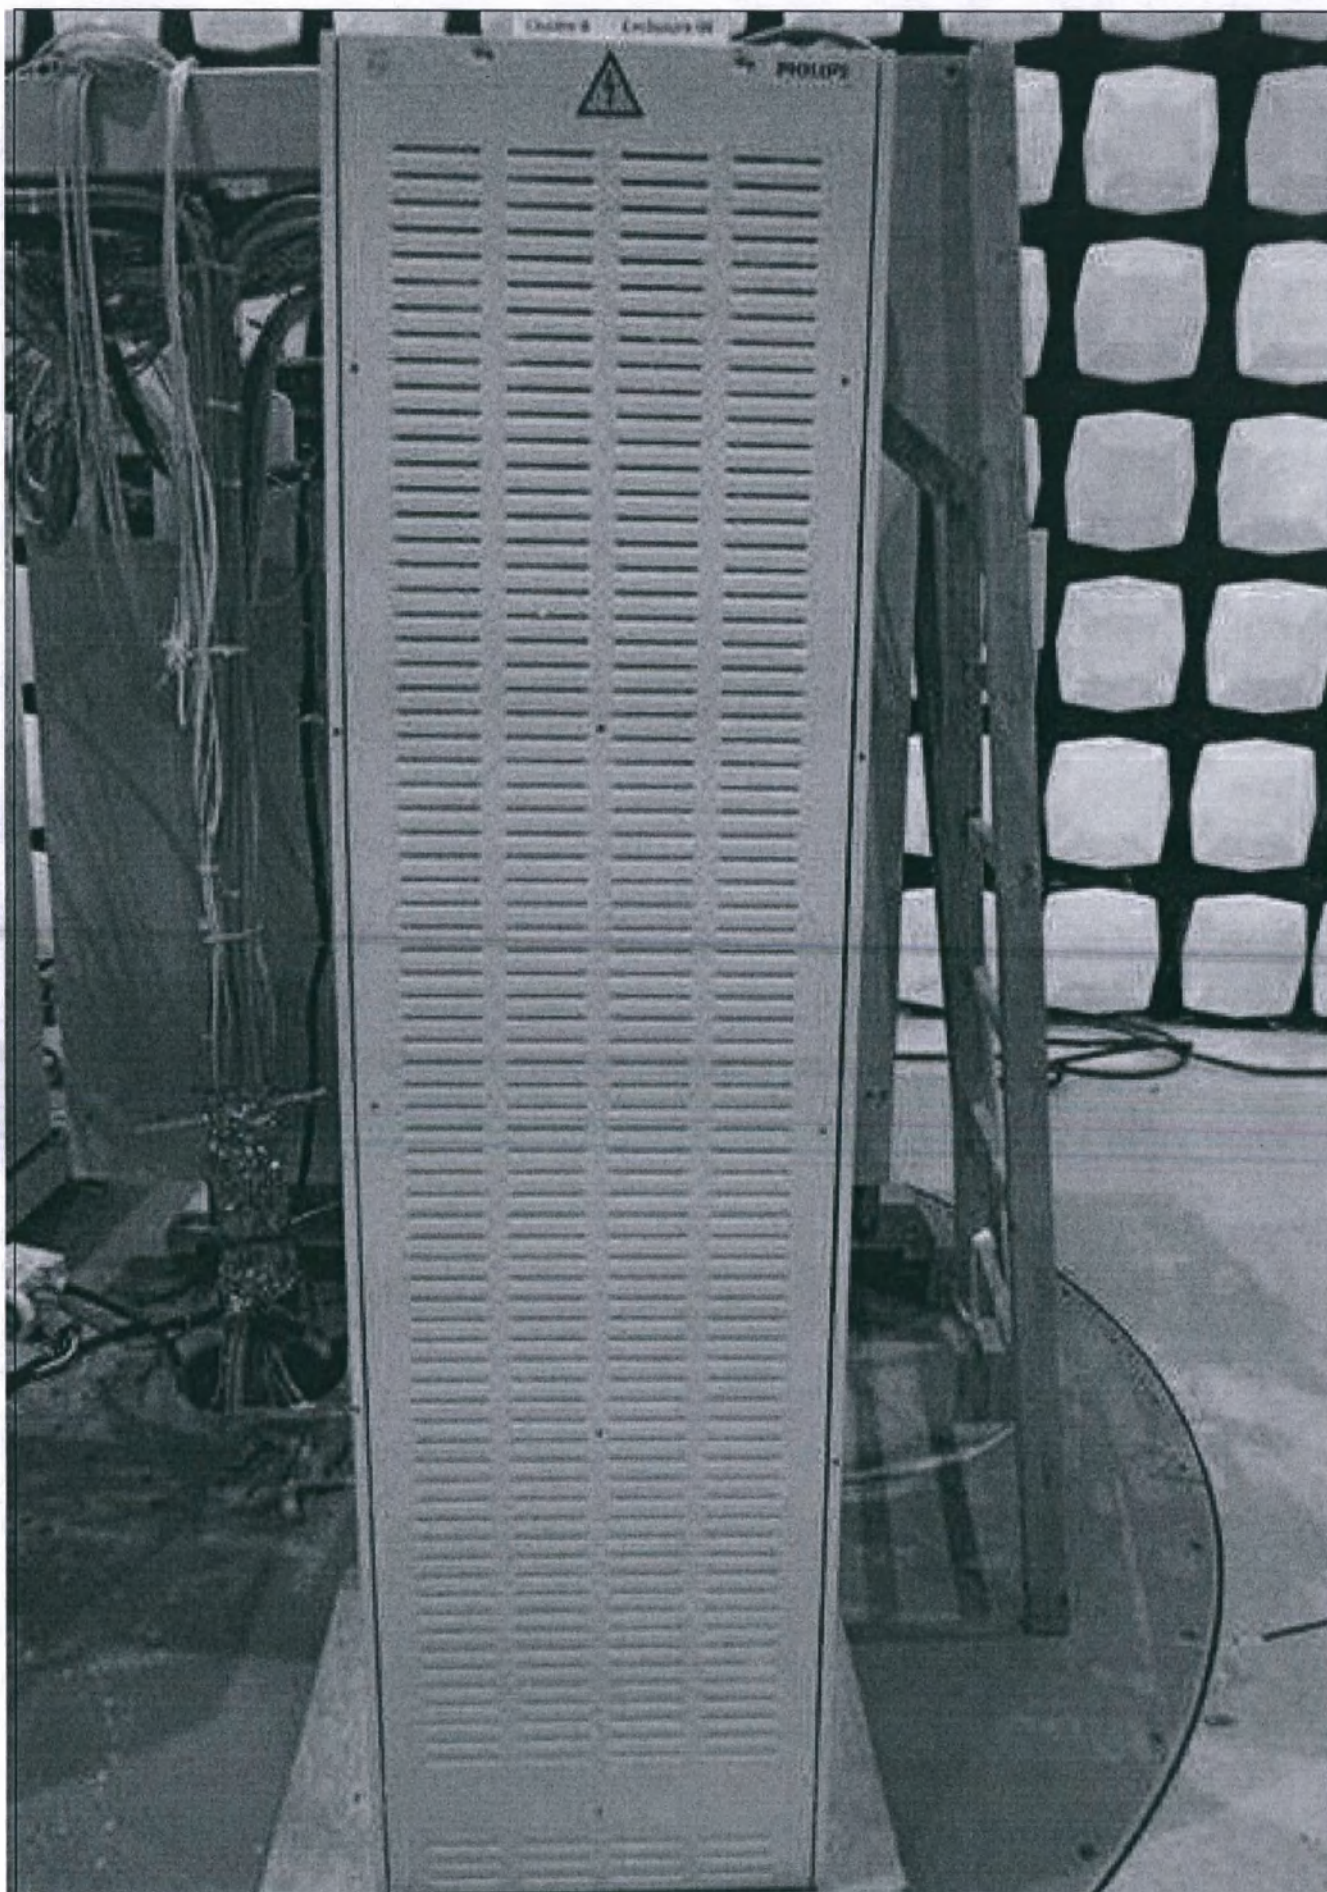


5.а. Шкаф управления.

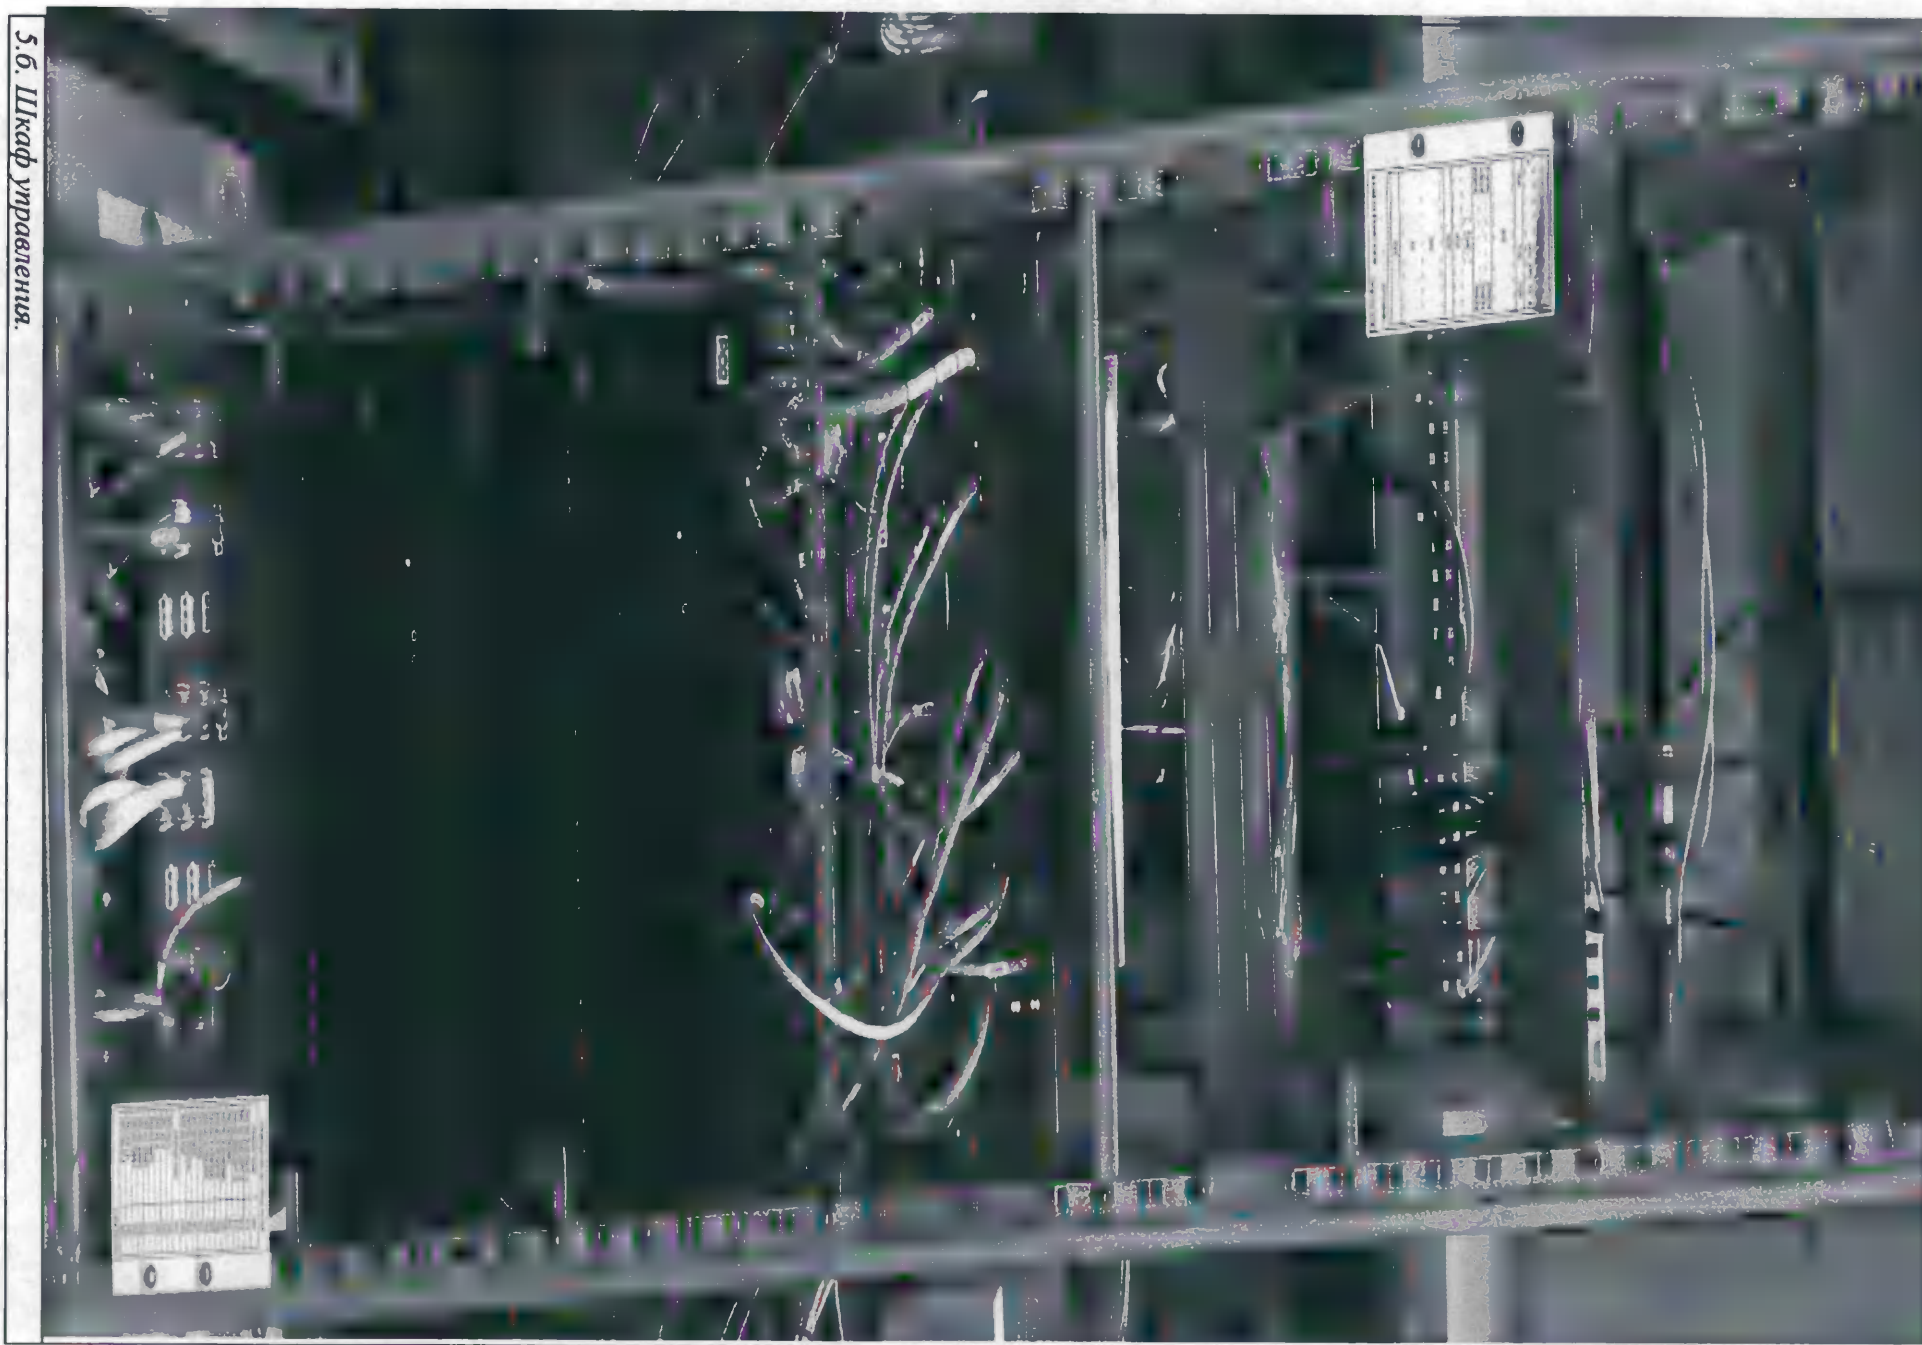

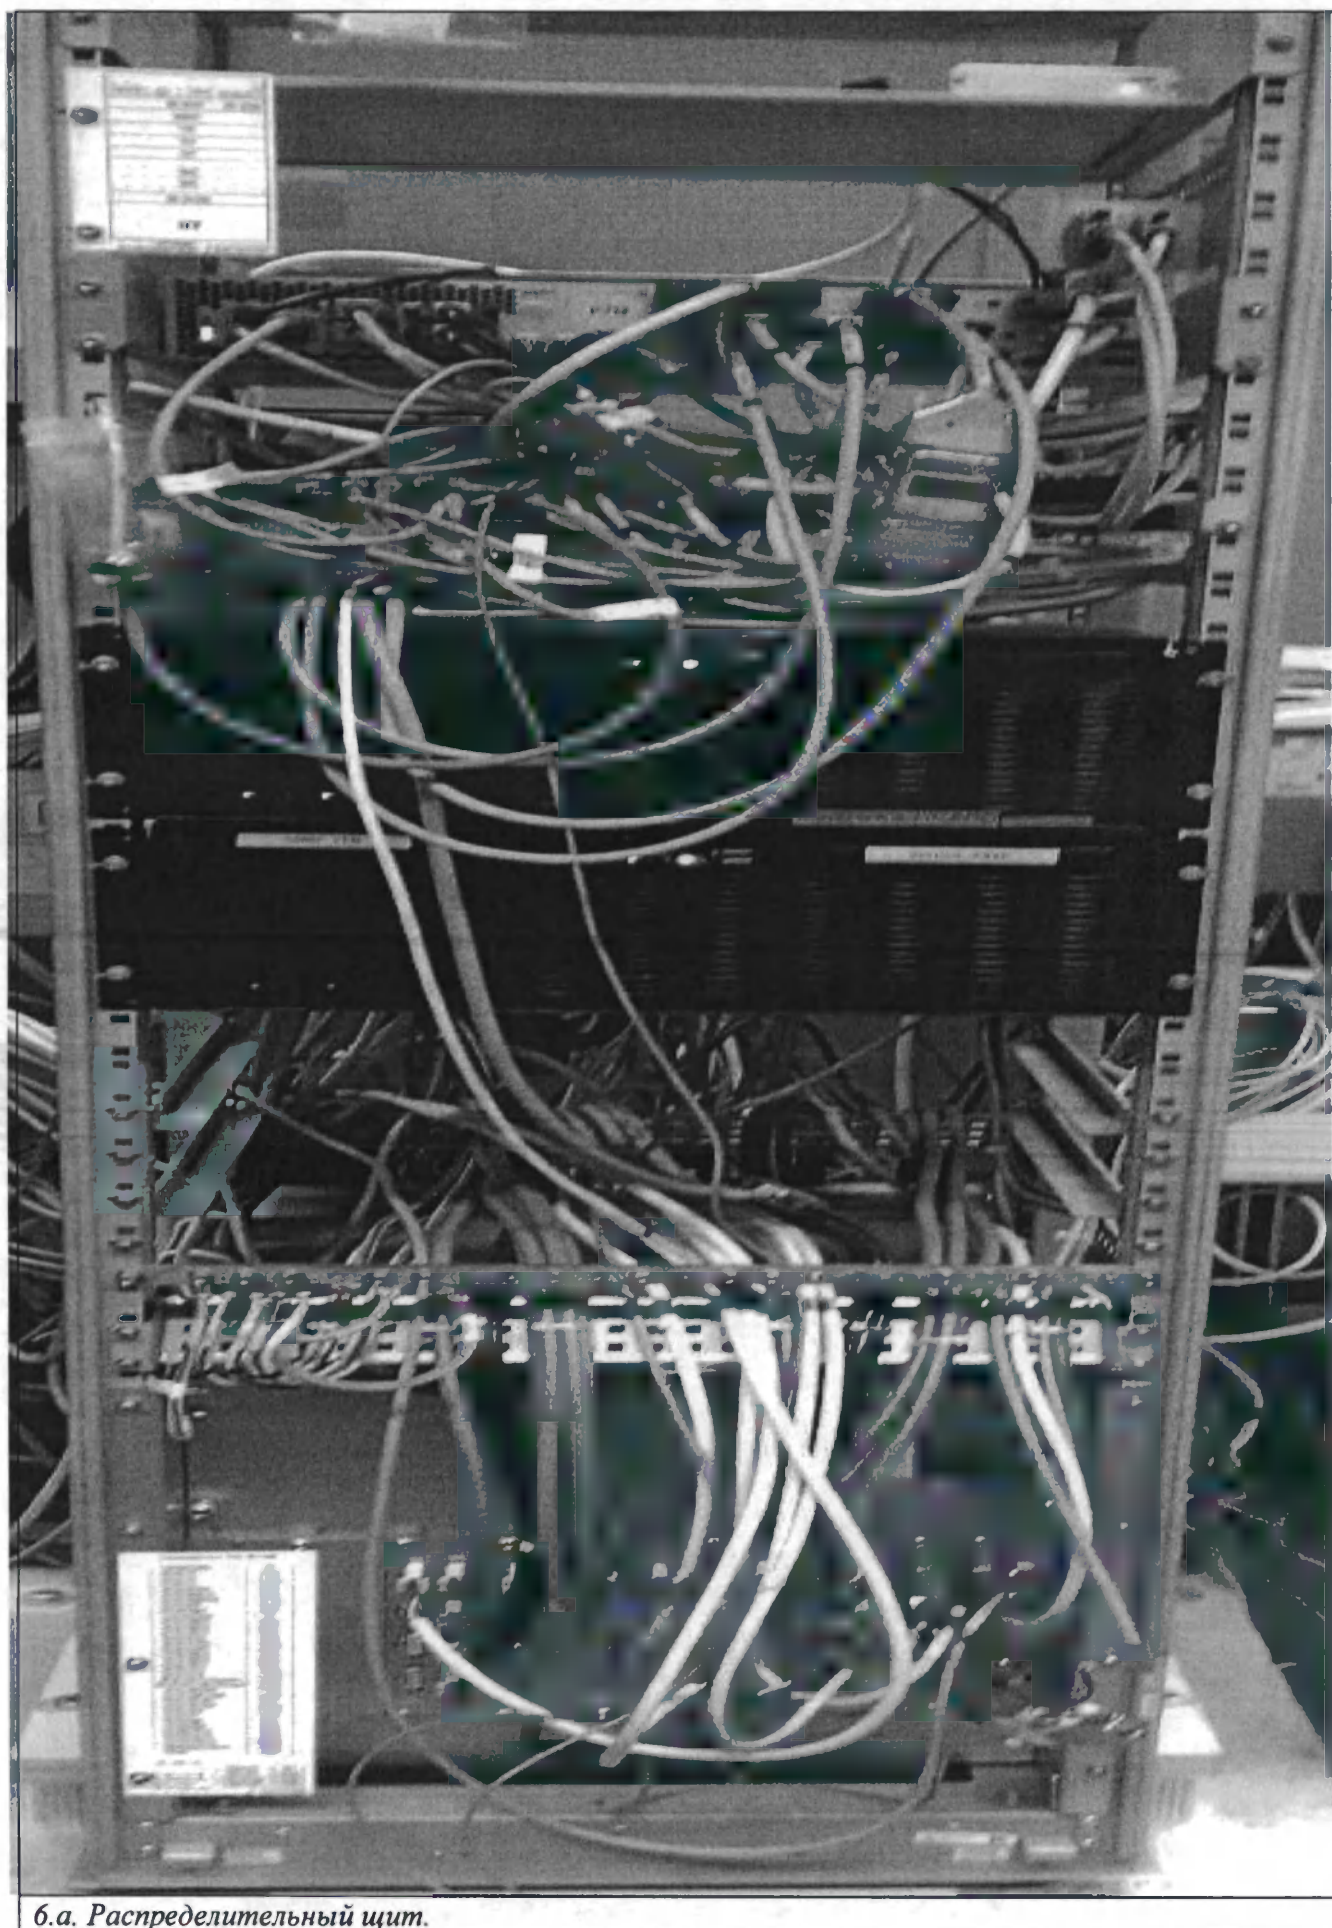


б.а. Распределительный щит.

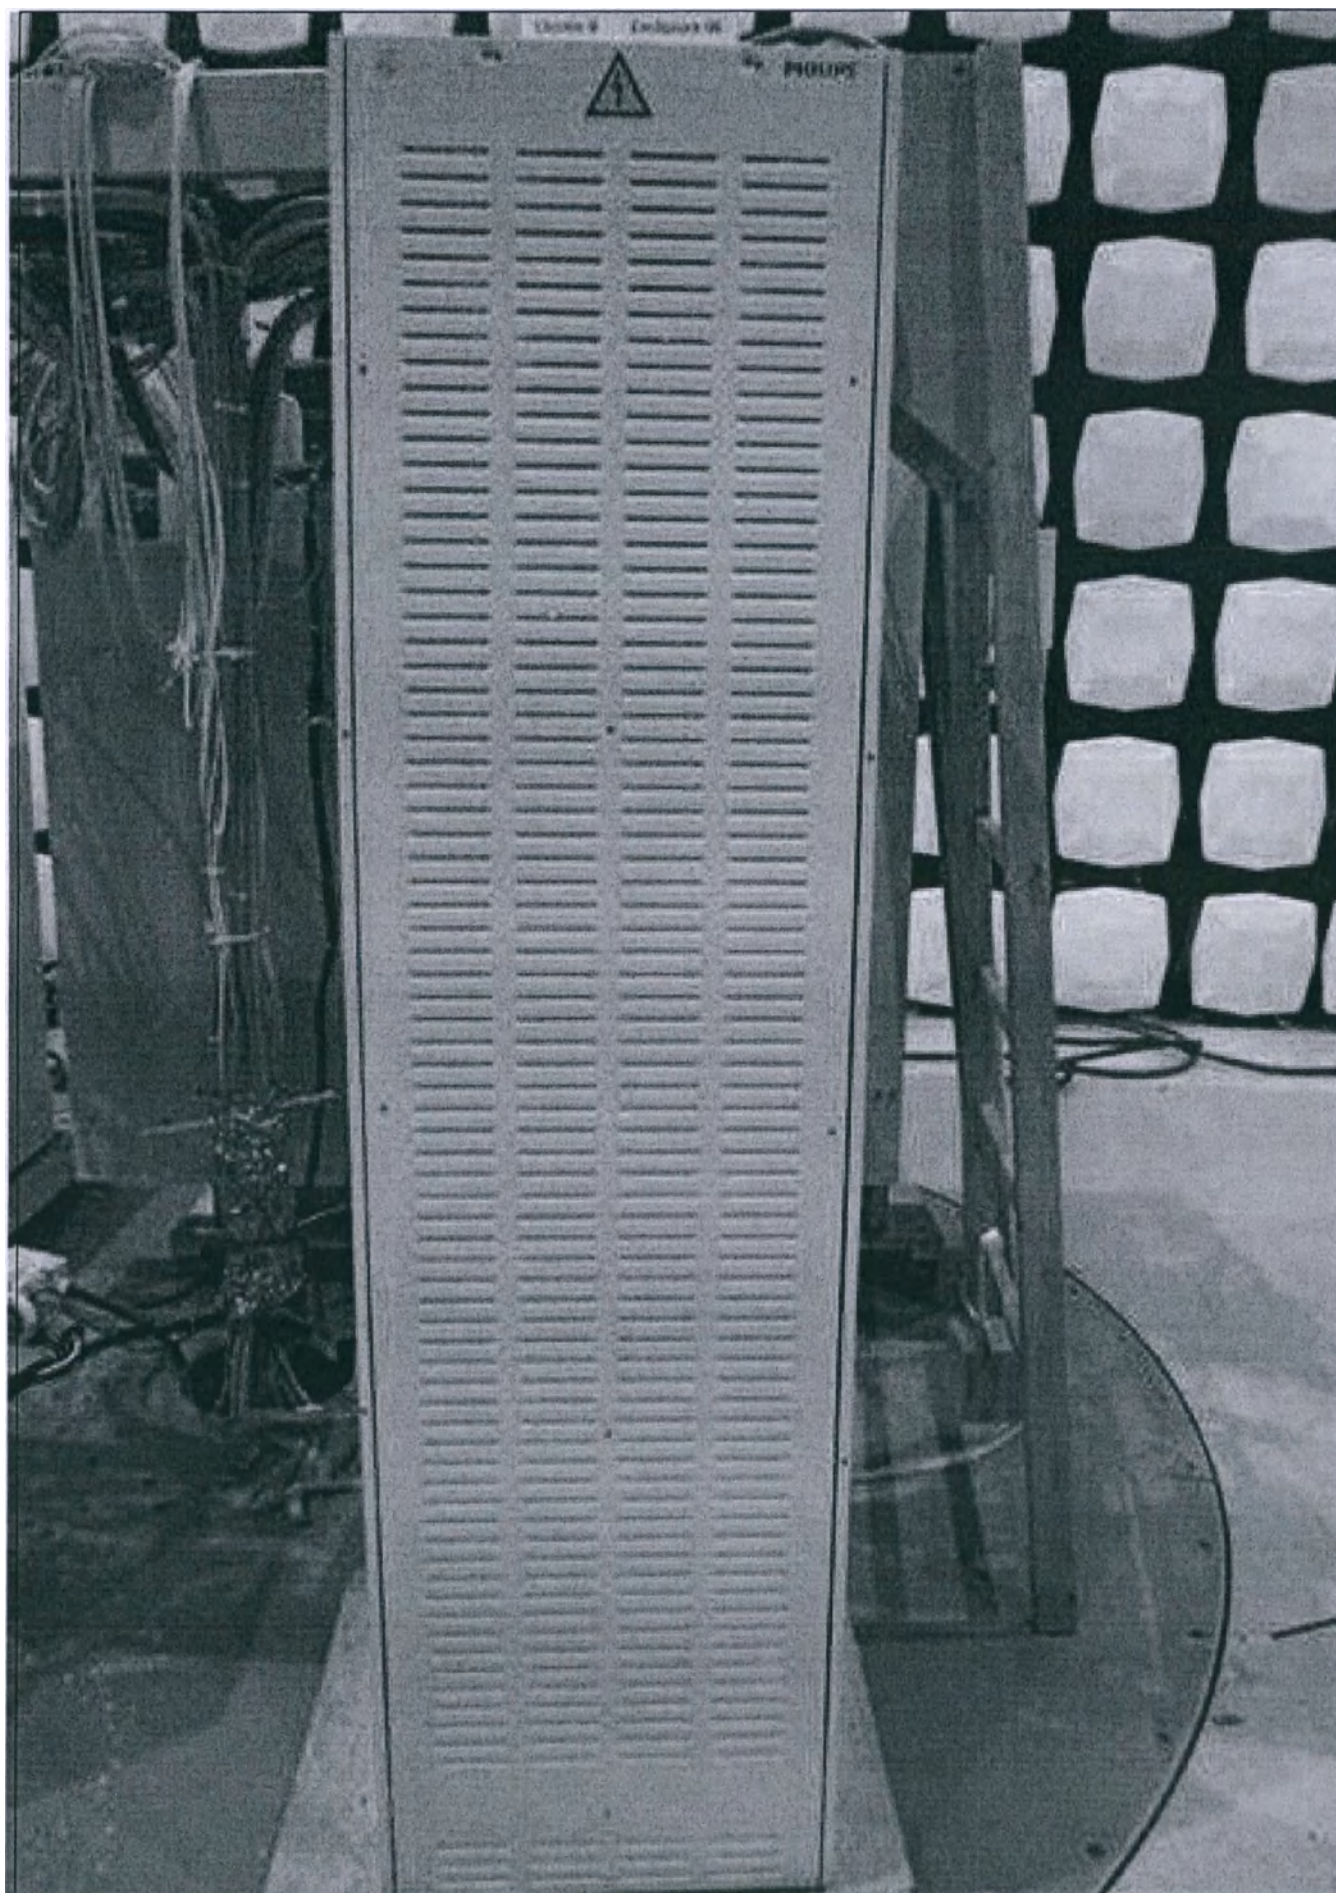


6.6. Распределительный щит.




7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

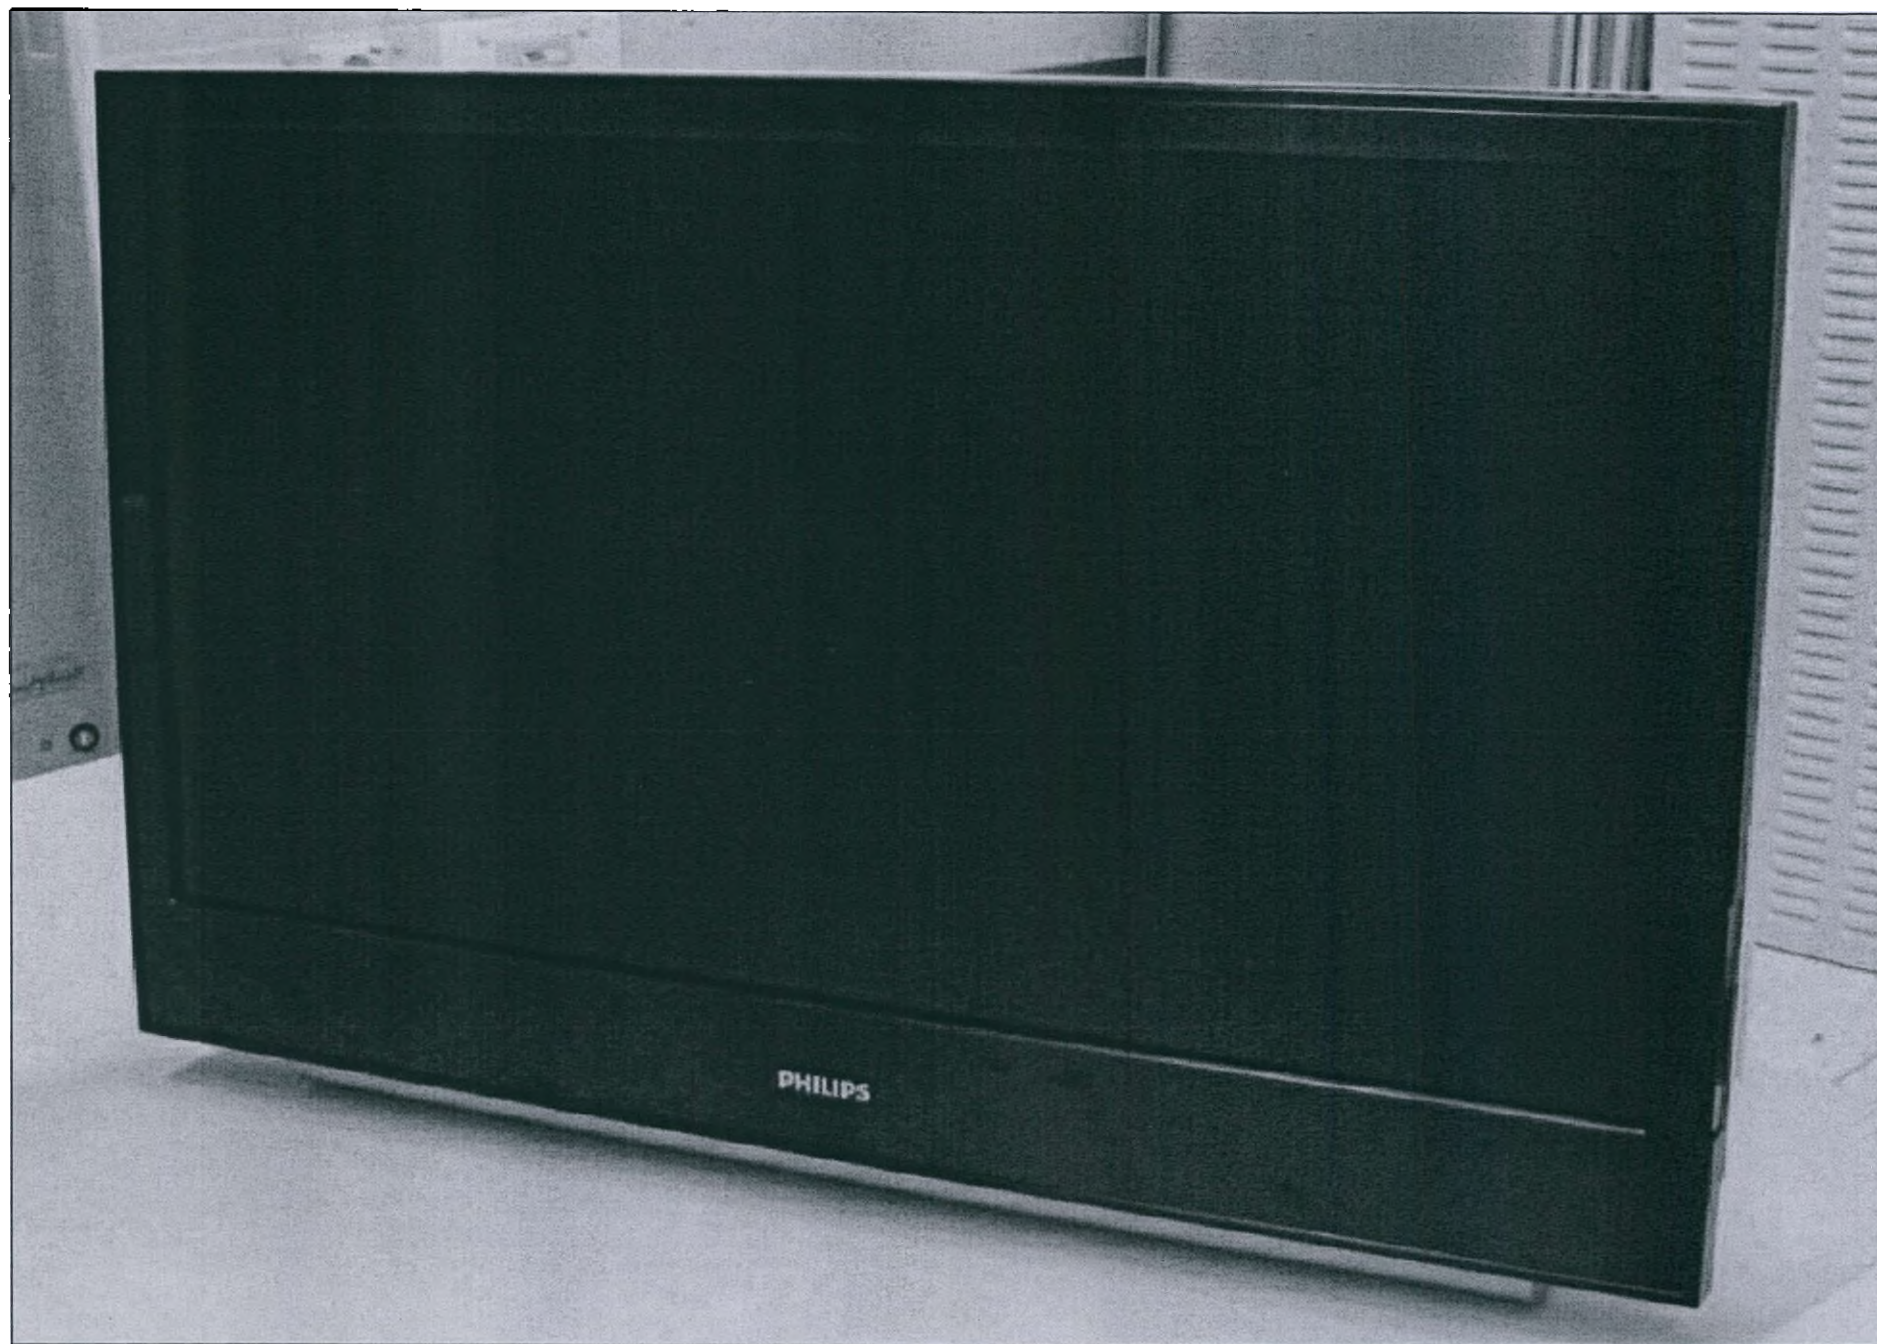

8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

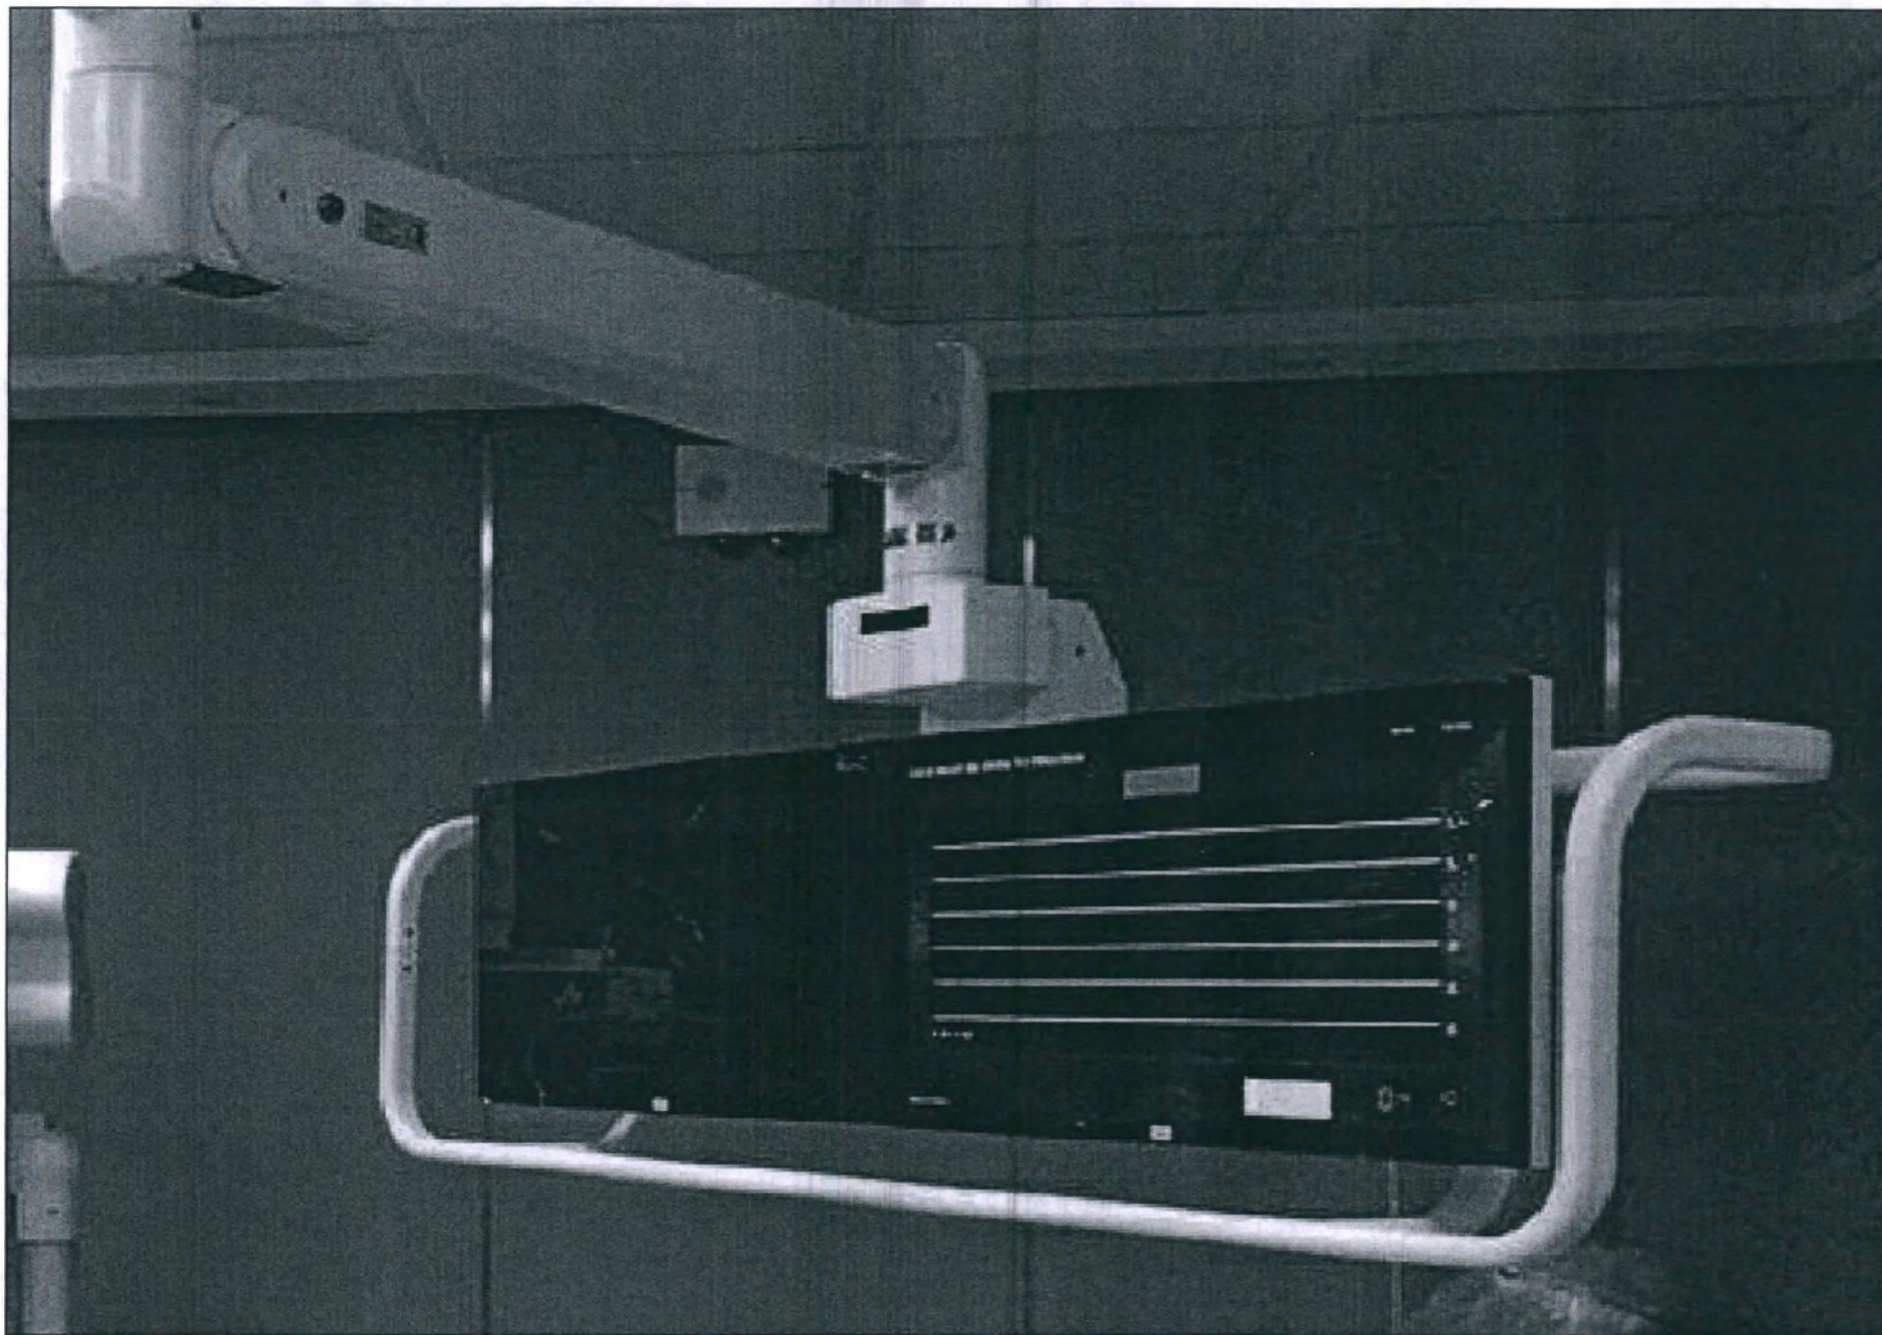


9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

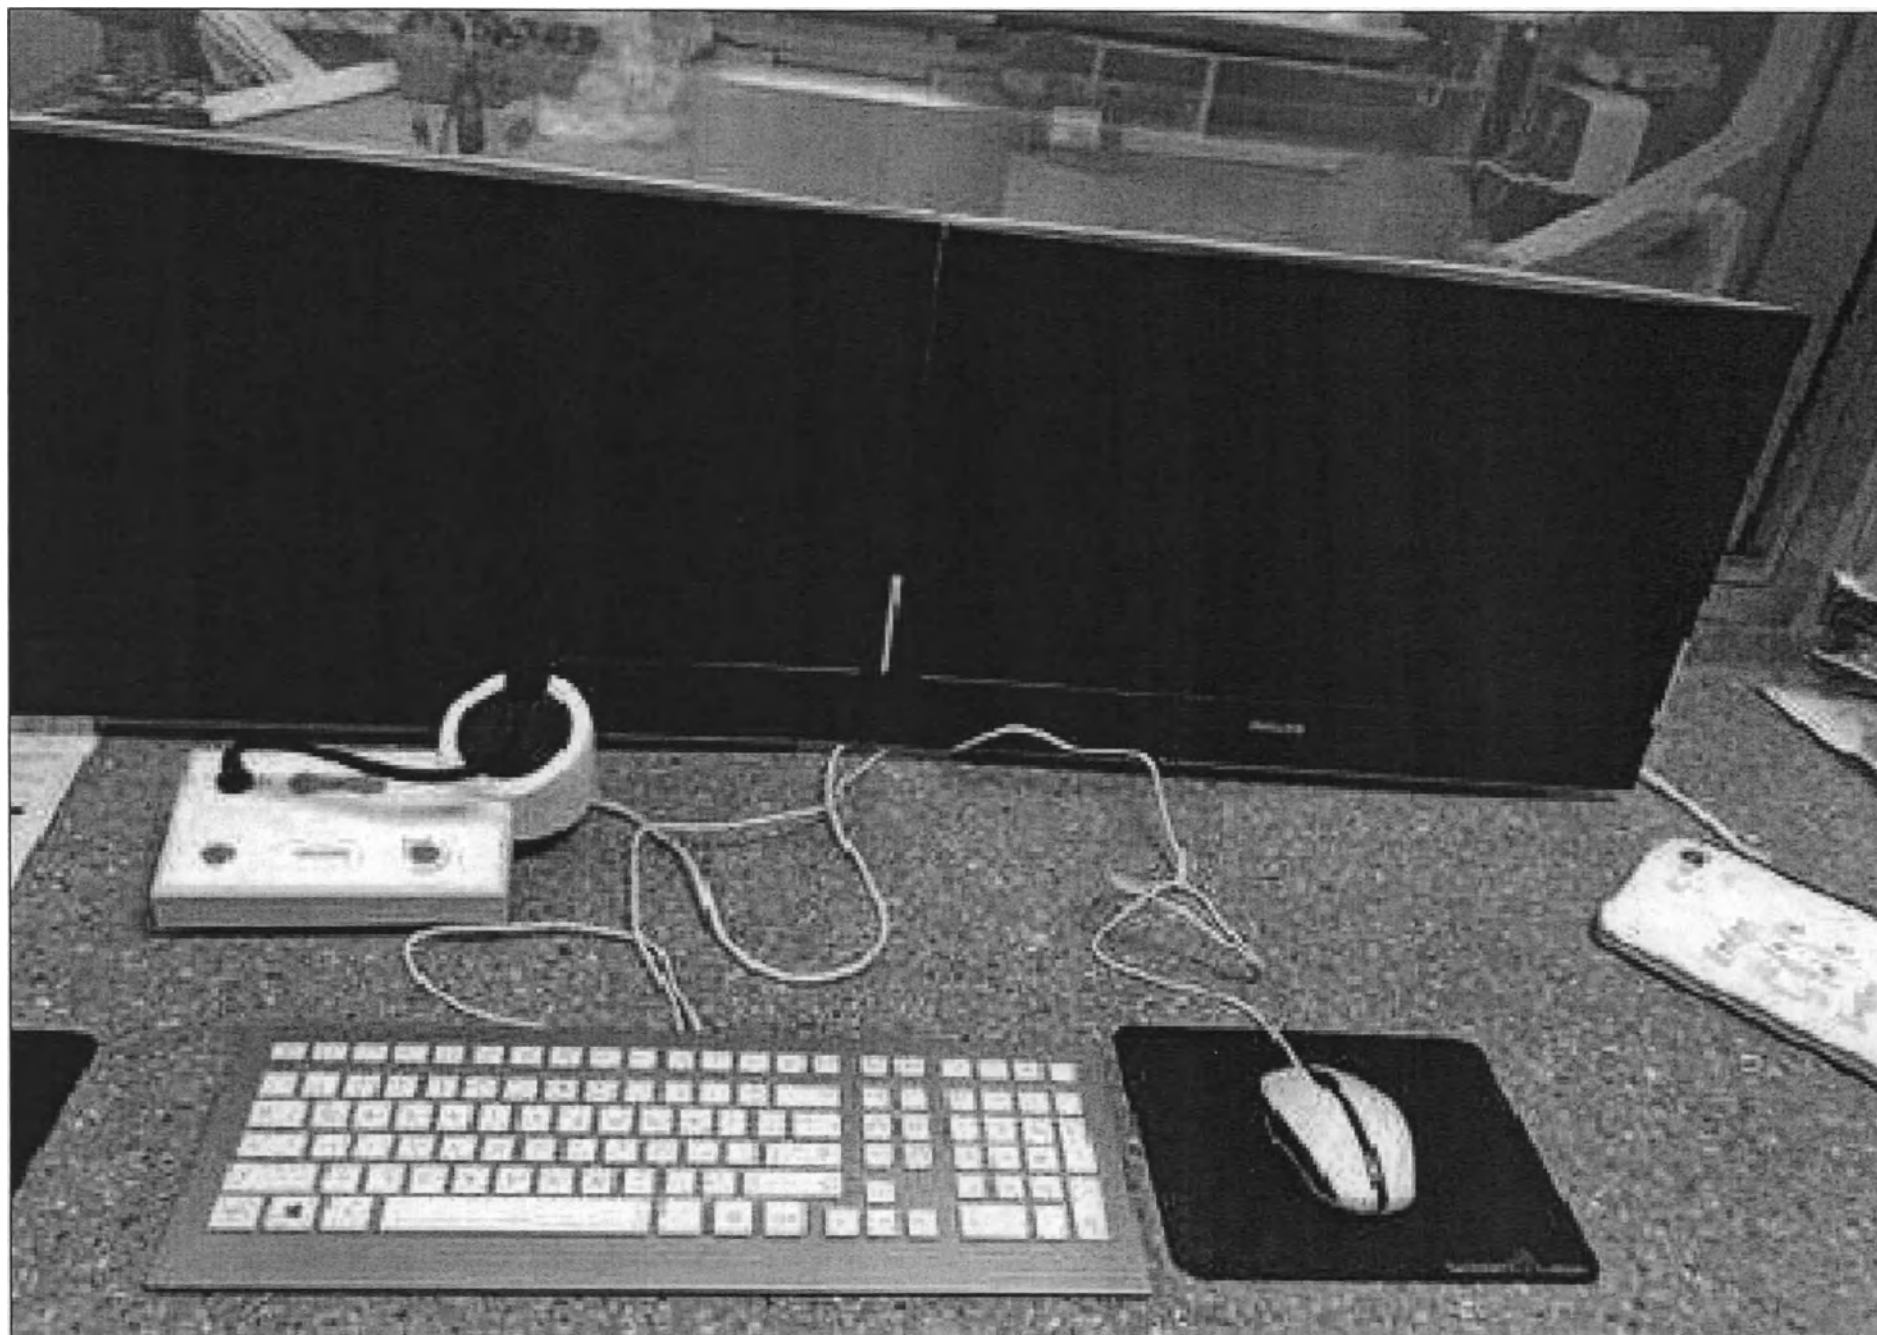


10.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.




10.6. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azigrip версия 1.1 и выше.

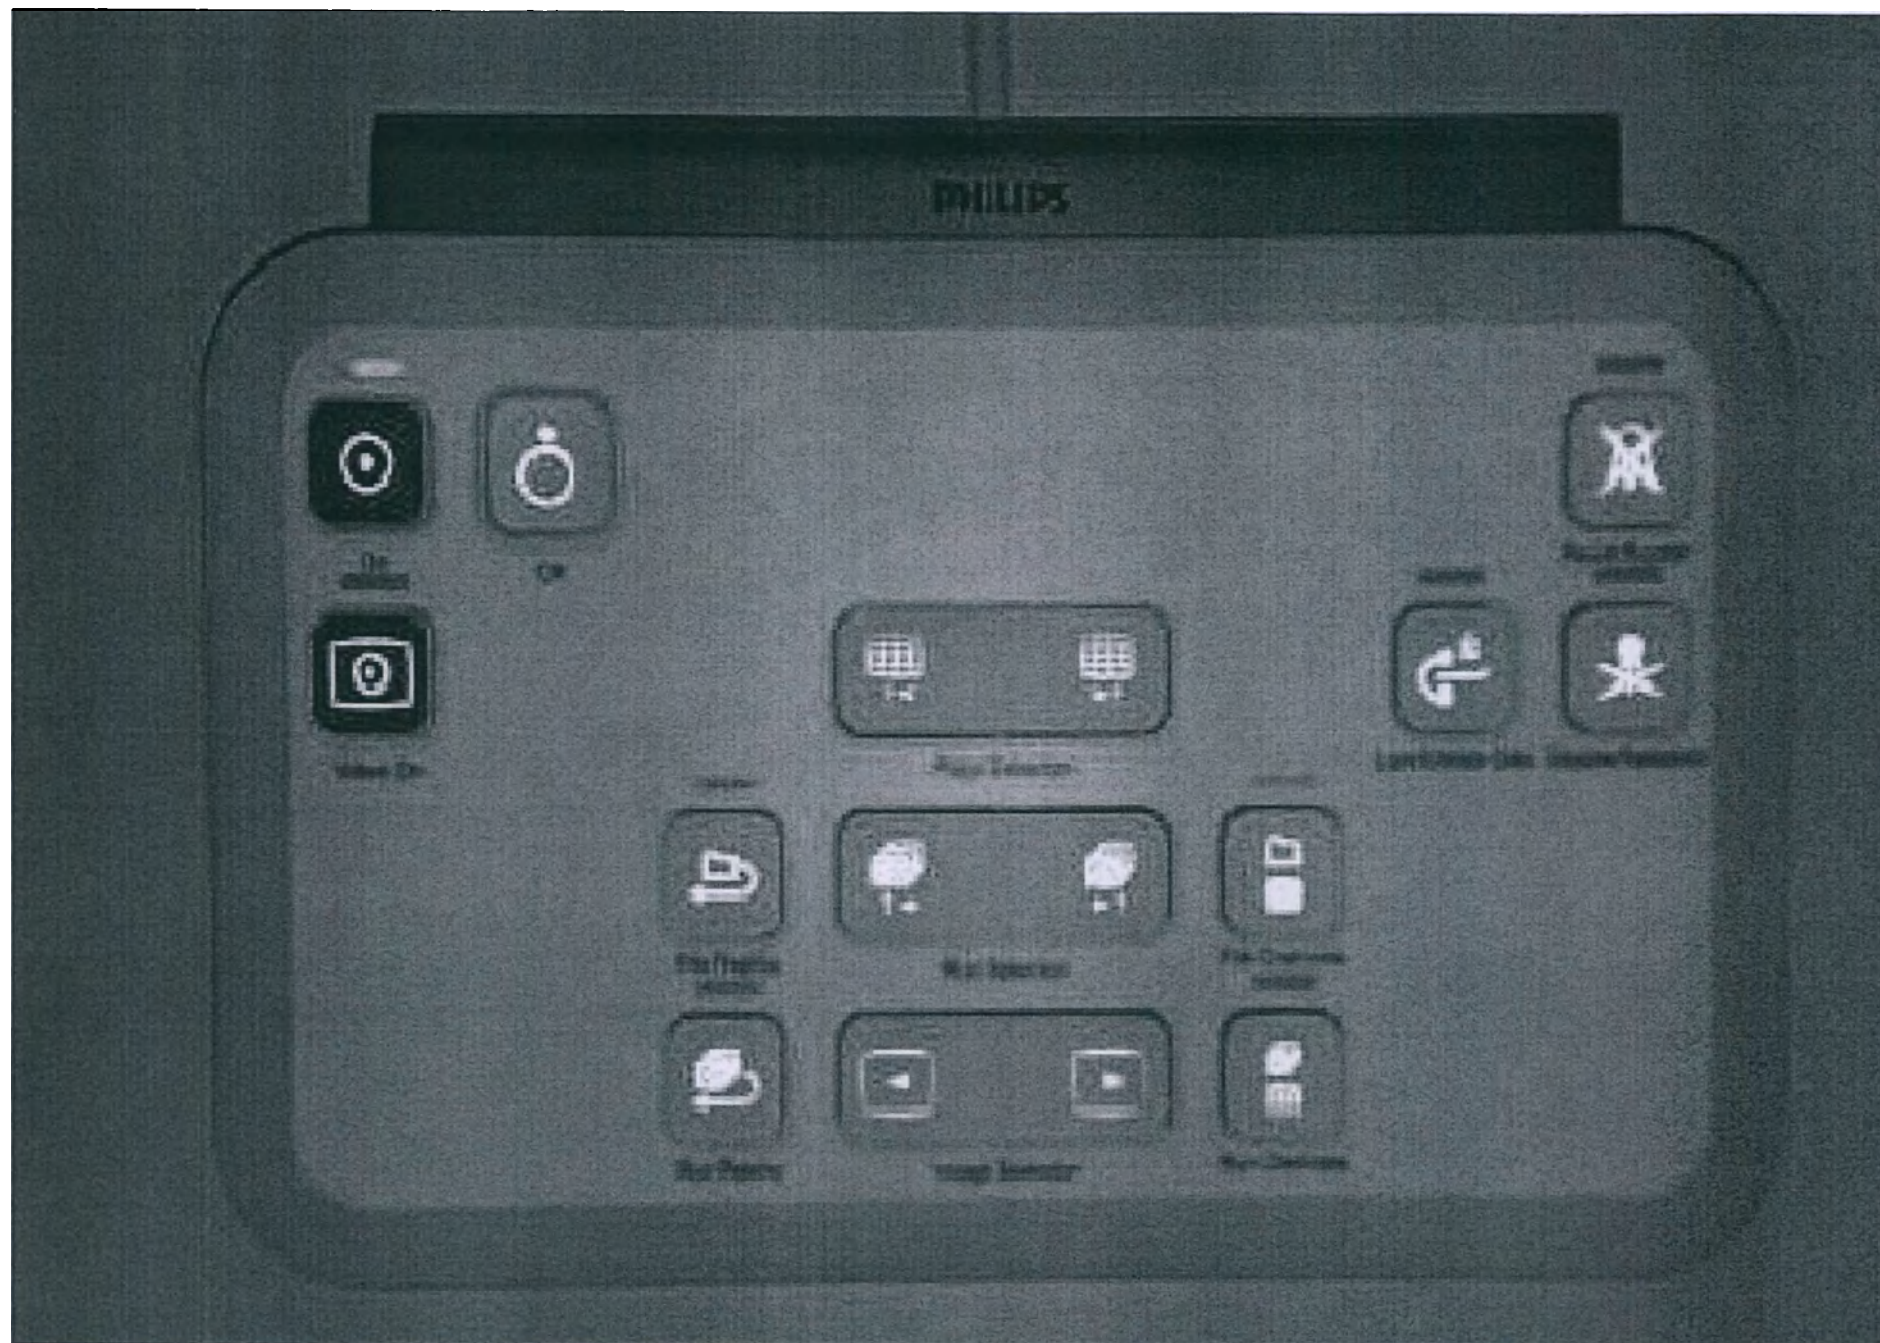


10.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; **Модуль просмотра**; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

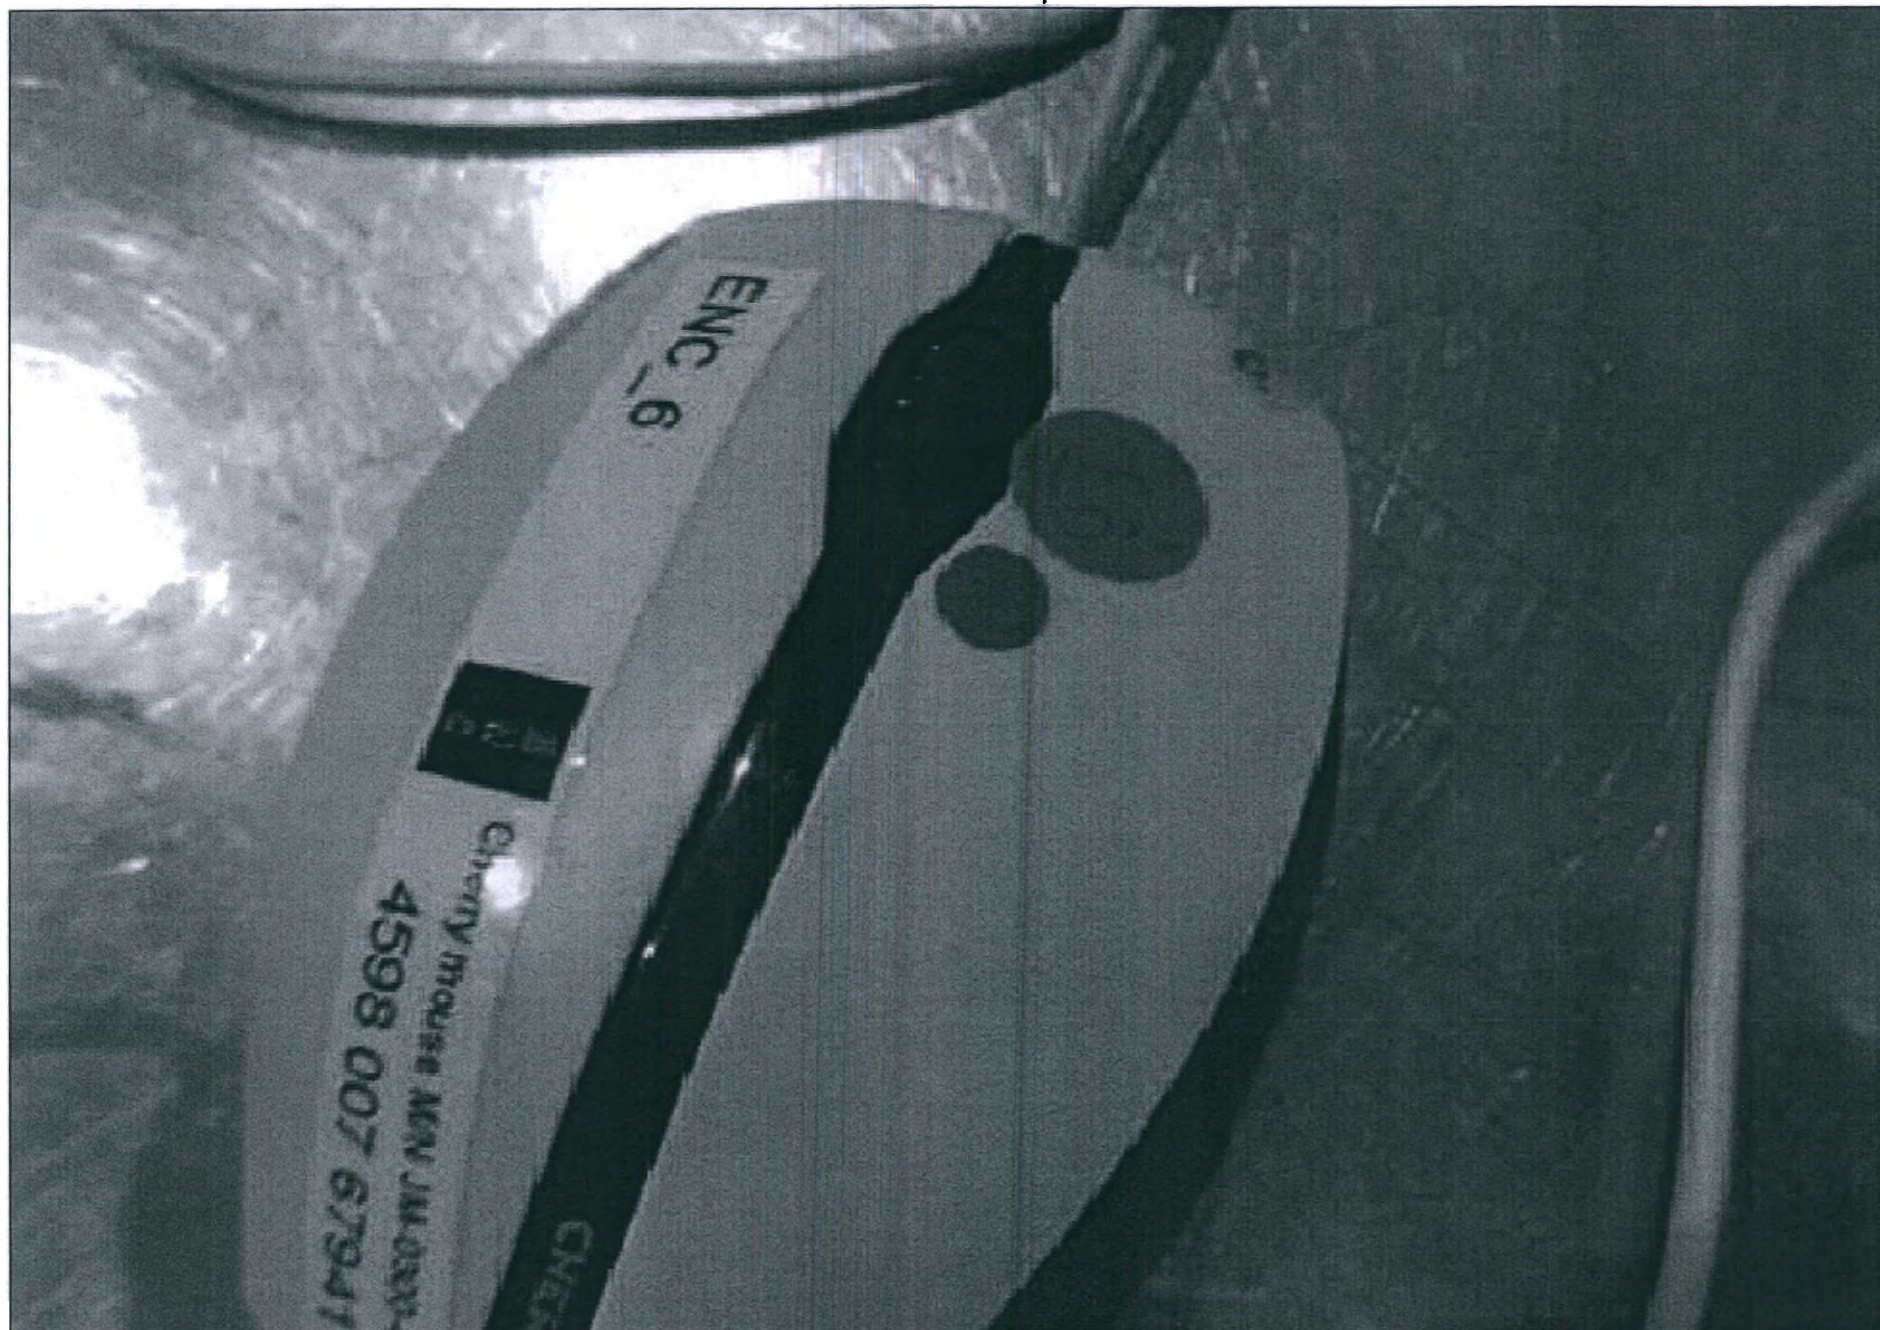


10.2. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

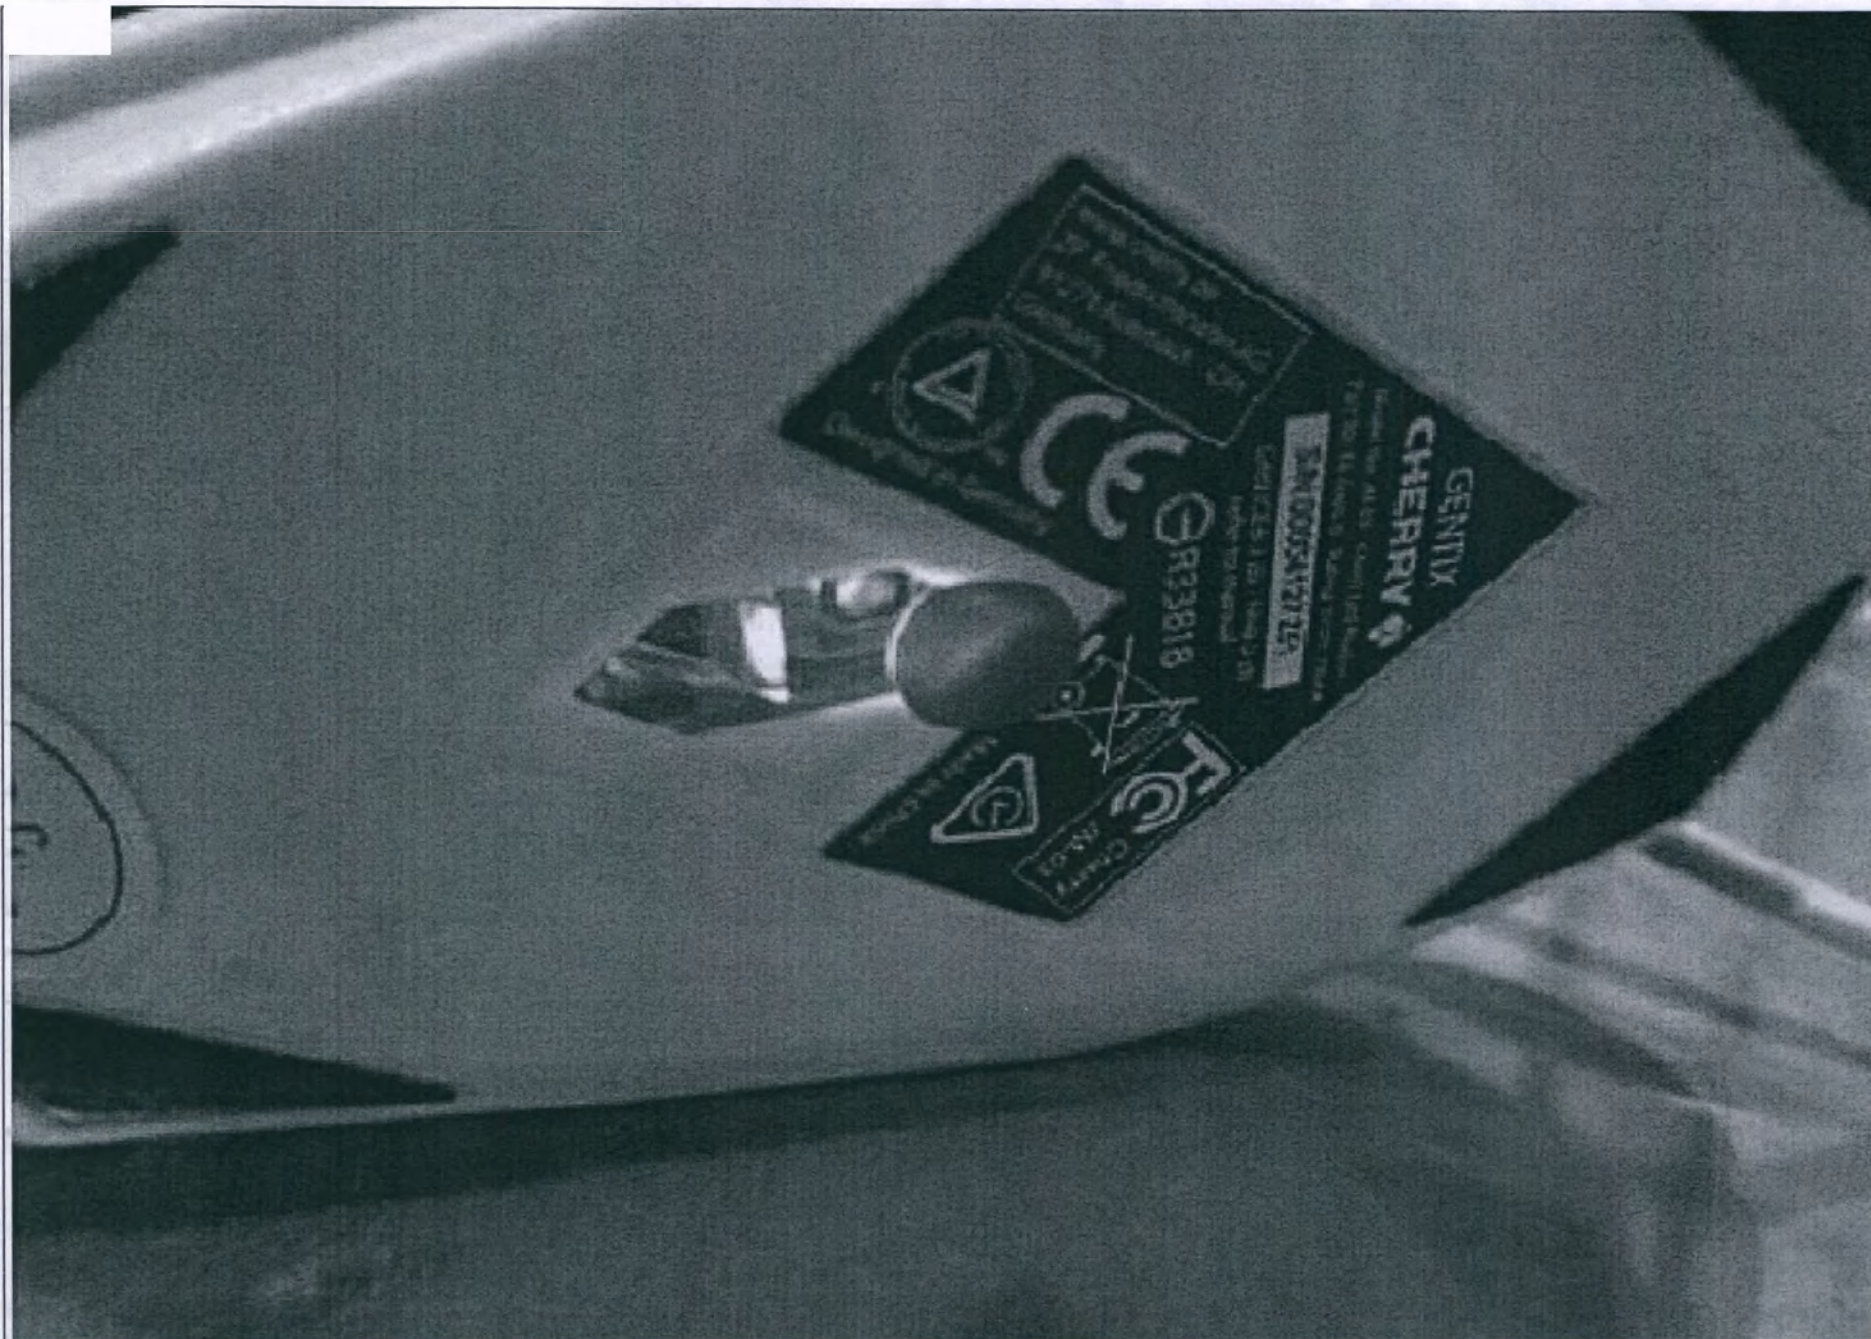

10.д. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; **Мышь**; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

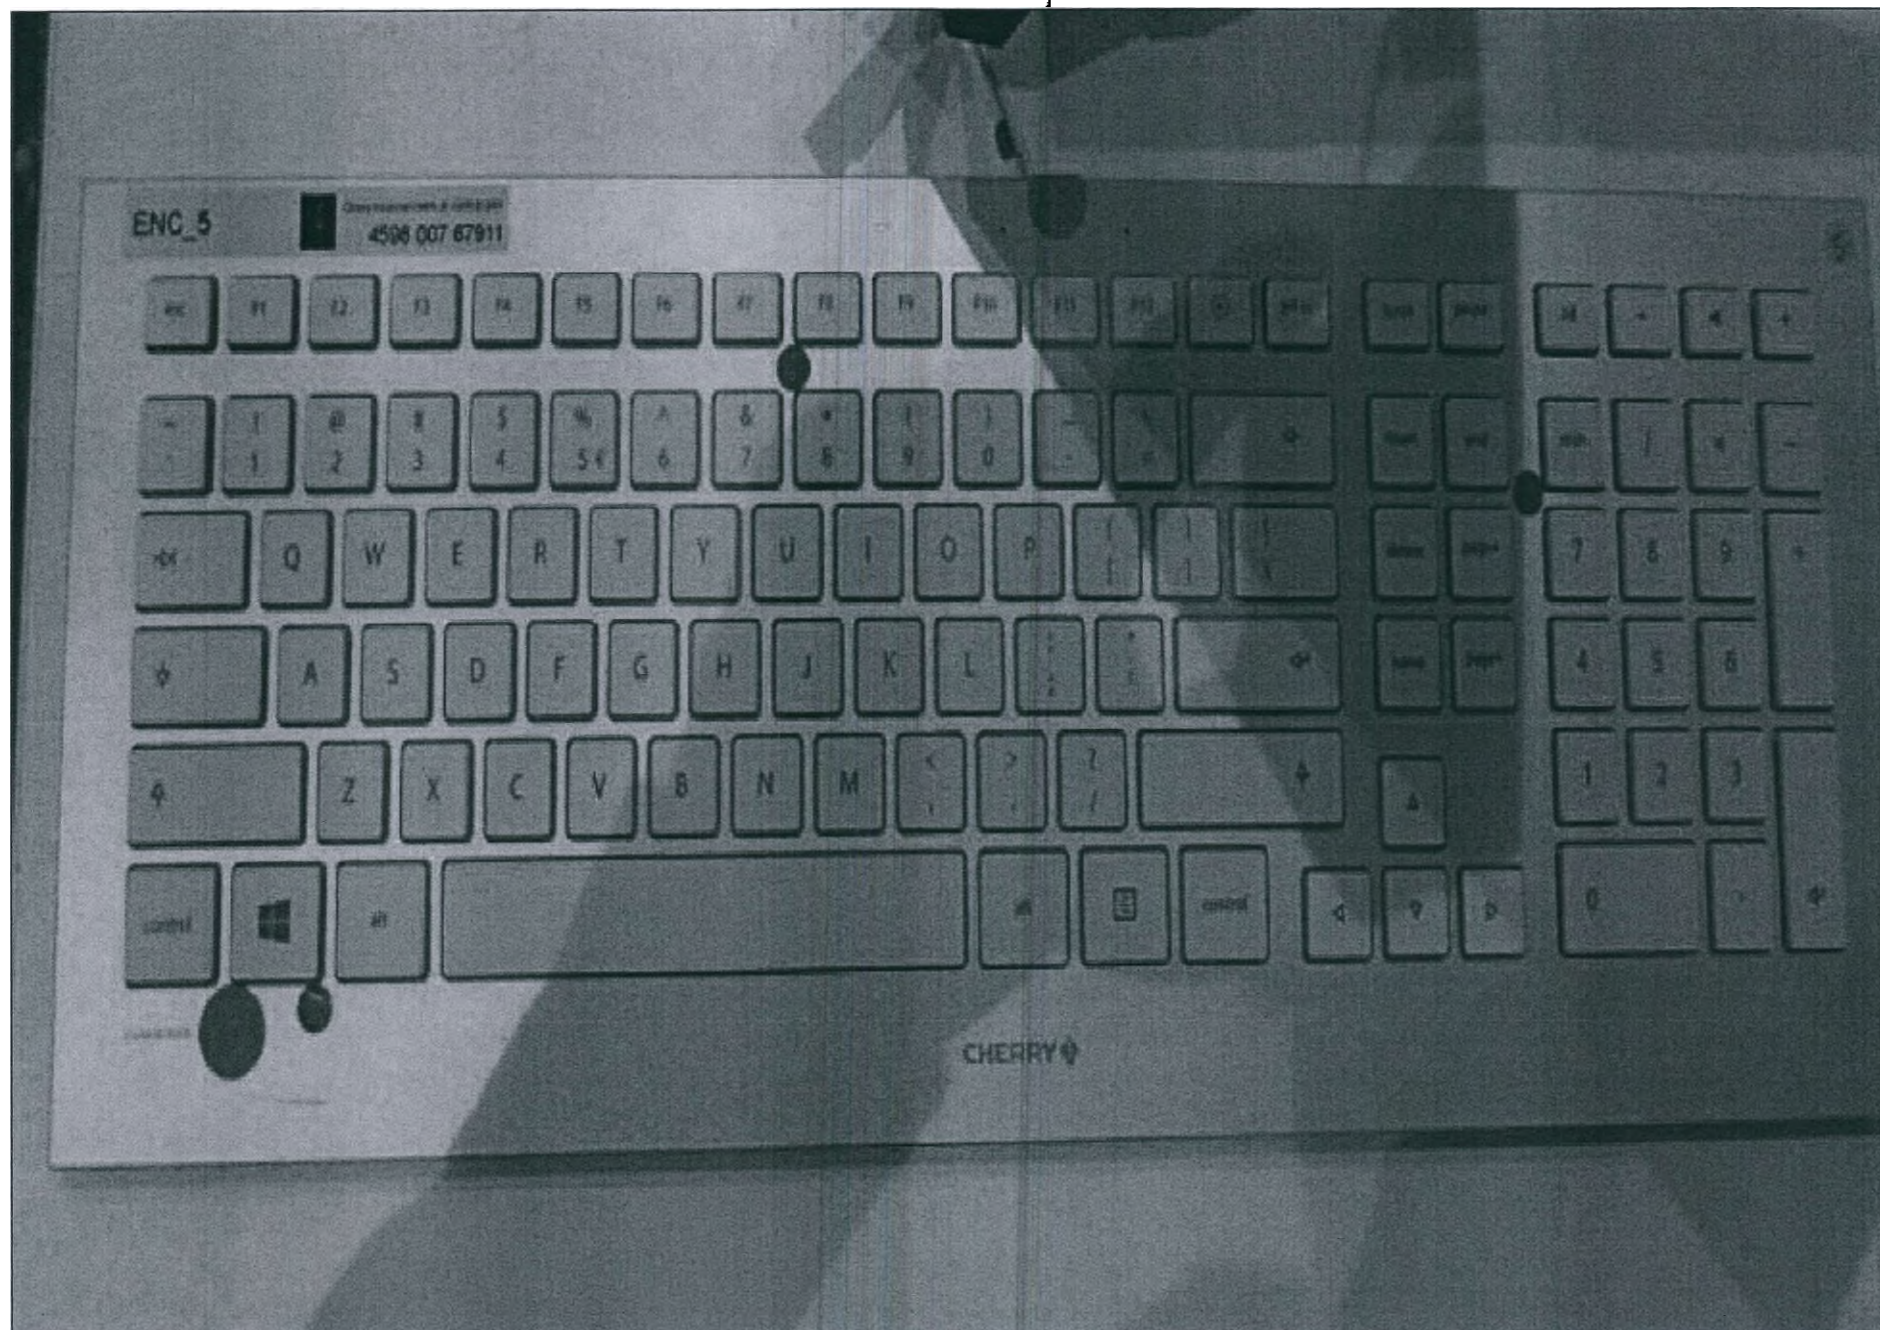


10.е. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

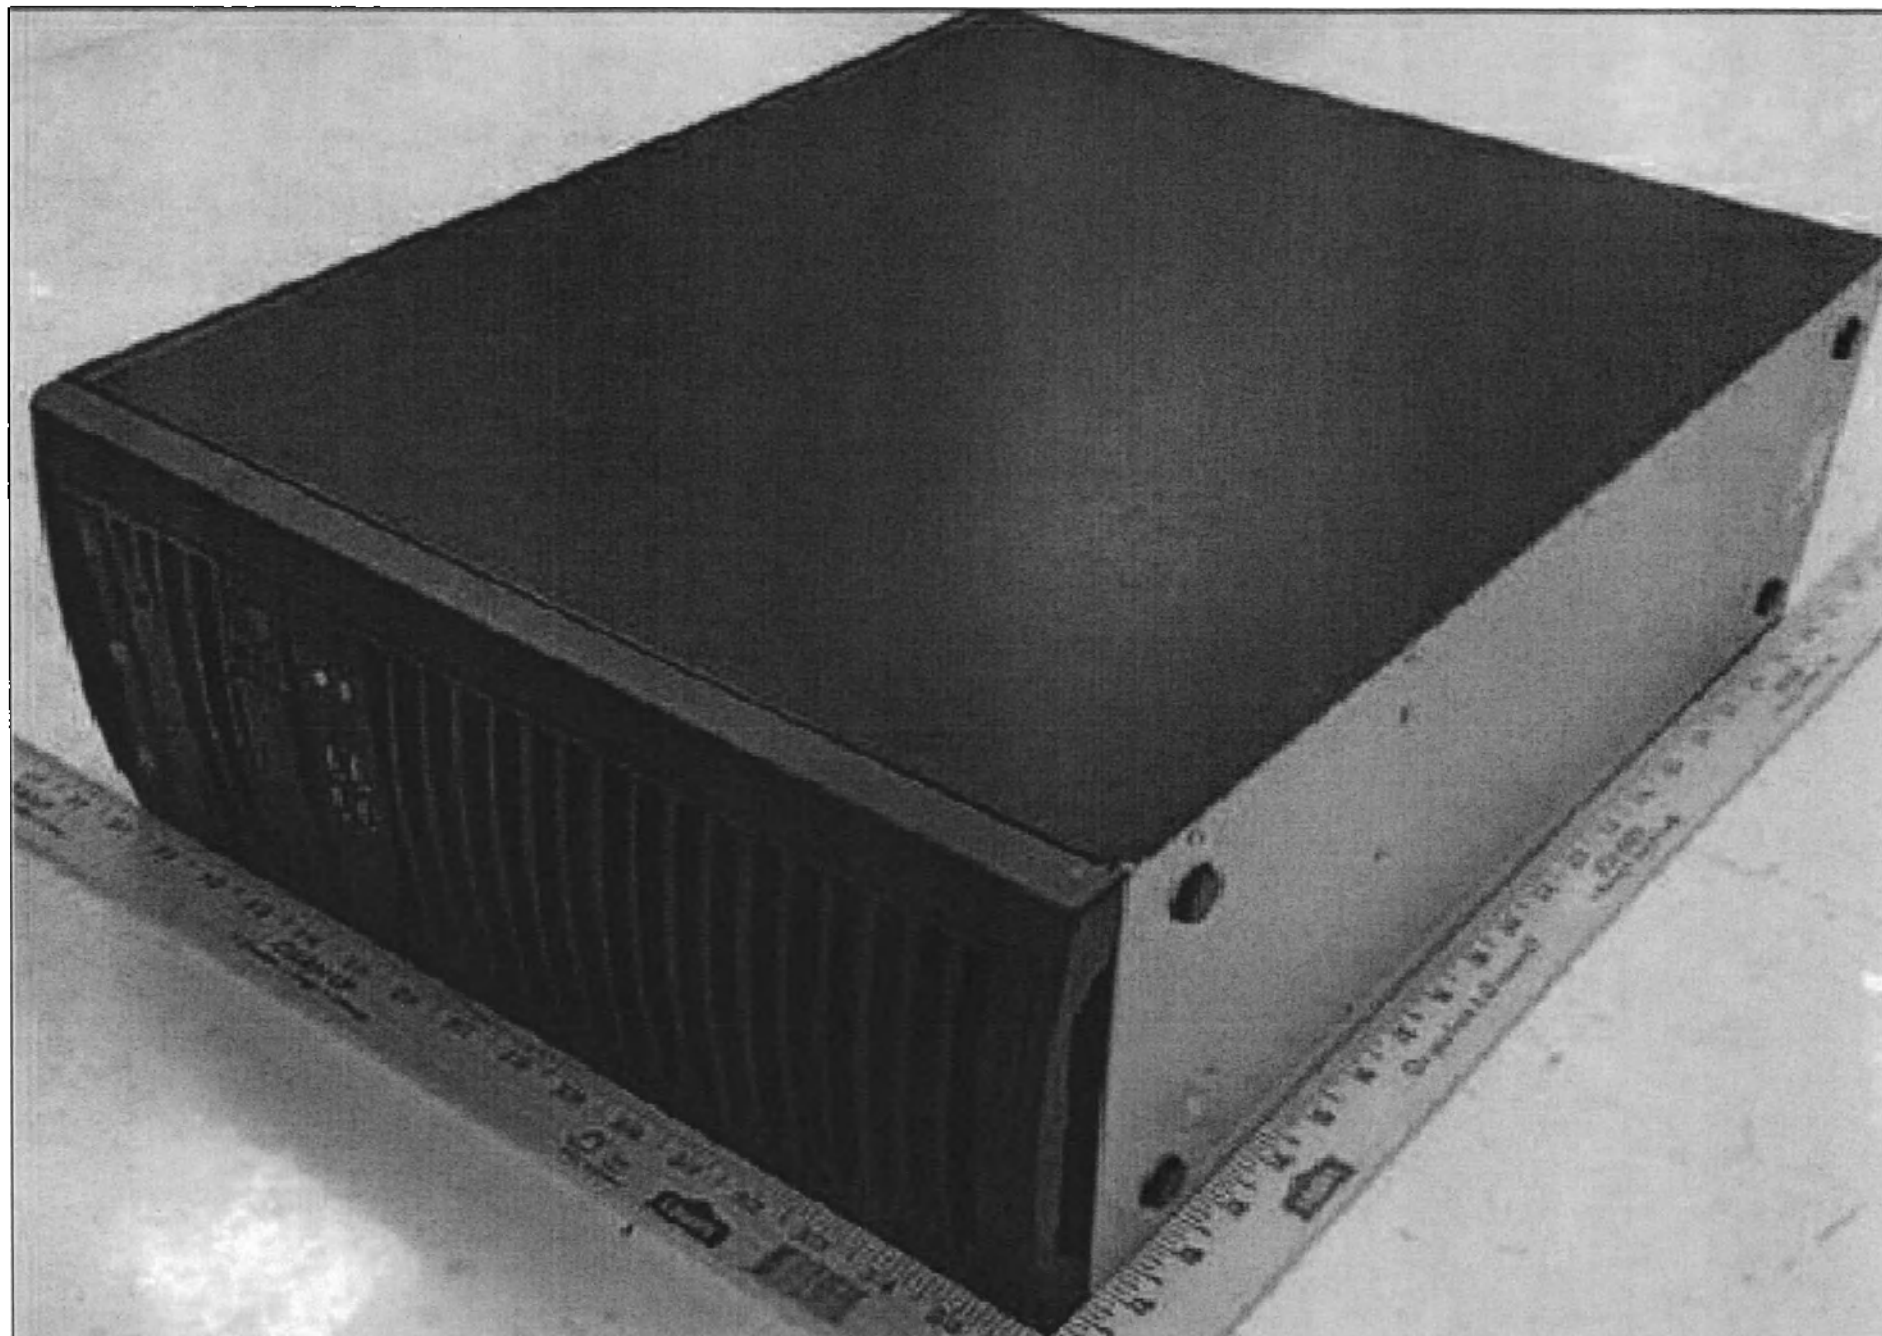

10.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Азигіон версия 1.1 и выше.




11. Ручной переключатель сдвига.

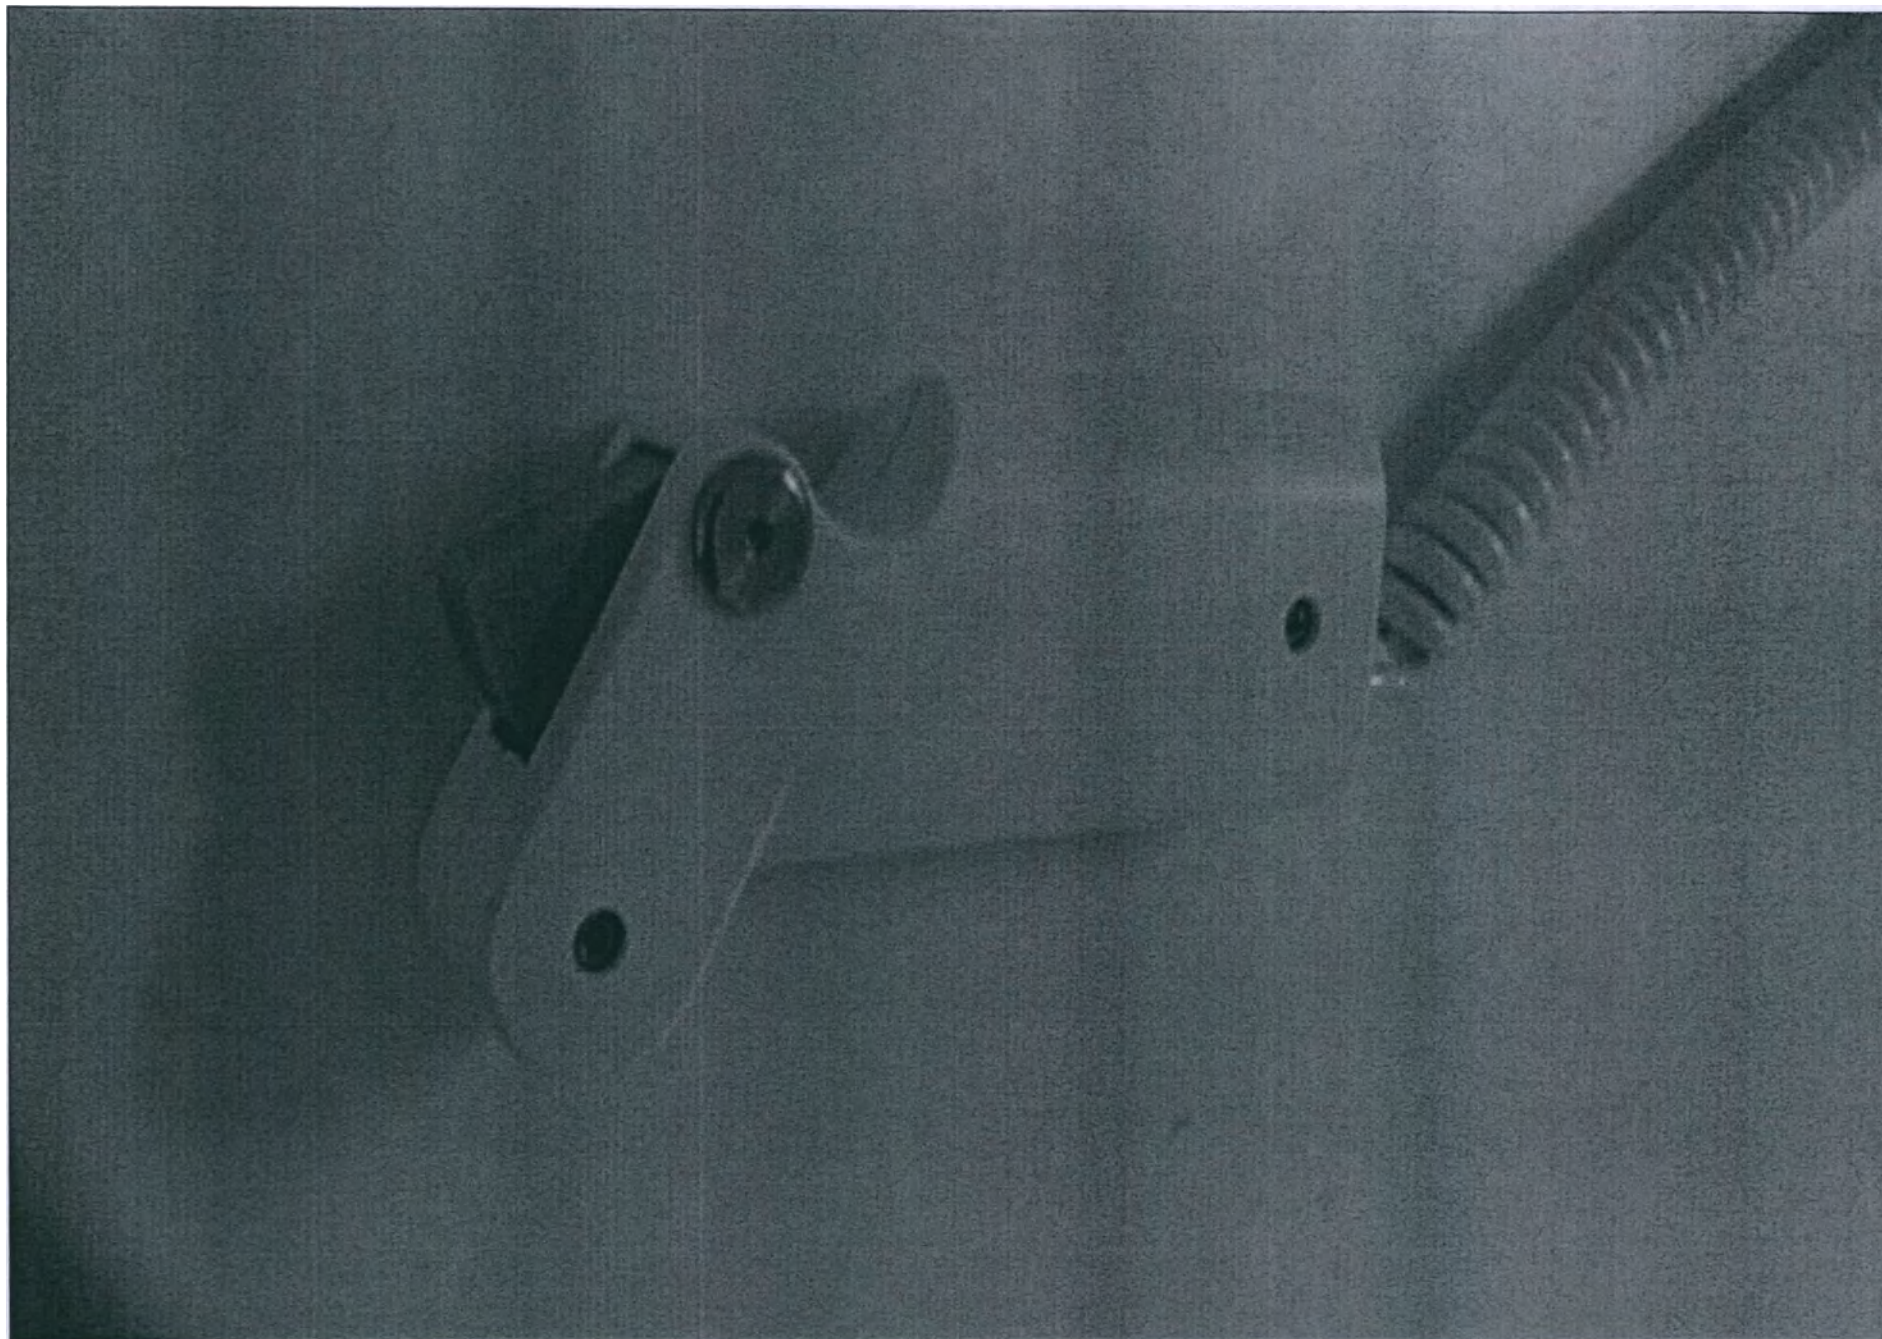


12. Регулятор скорости.




13. Ручной переключатель экспозиции.

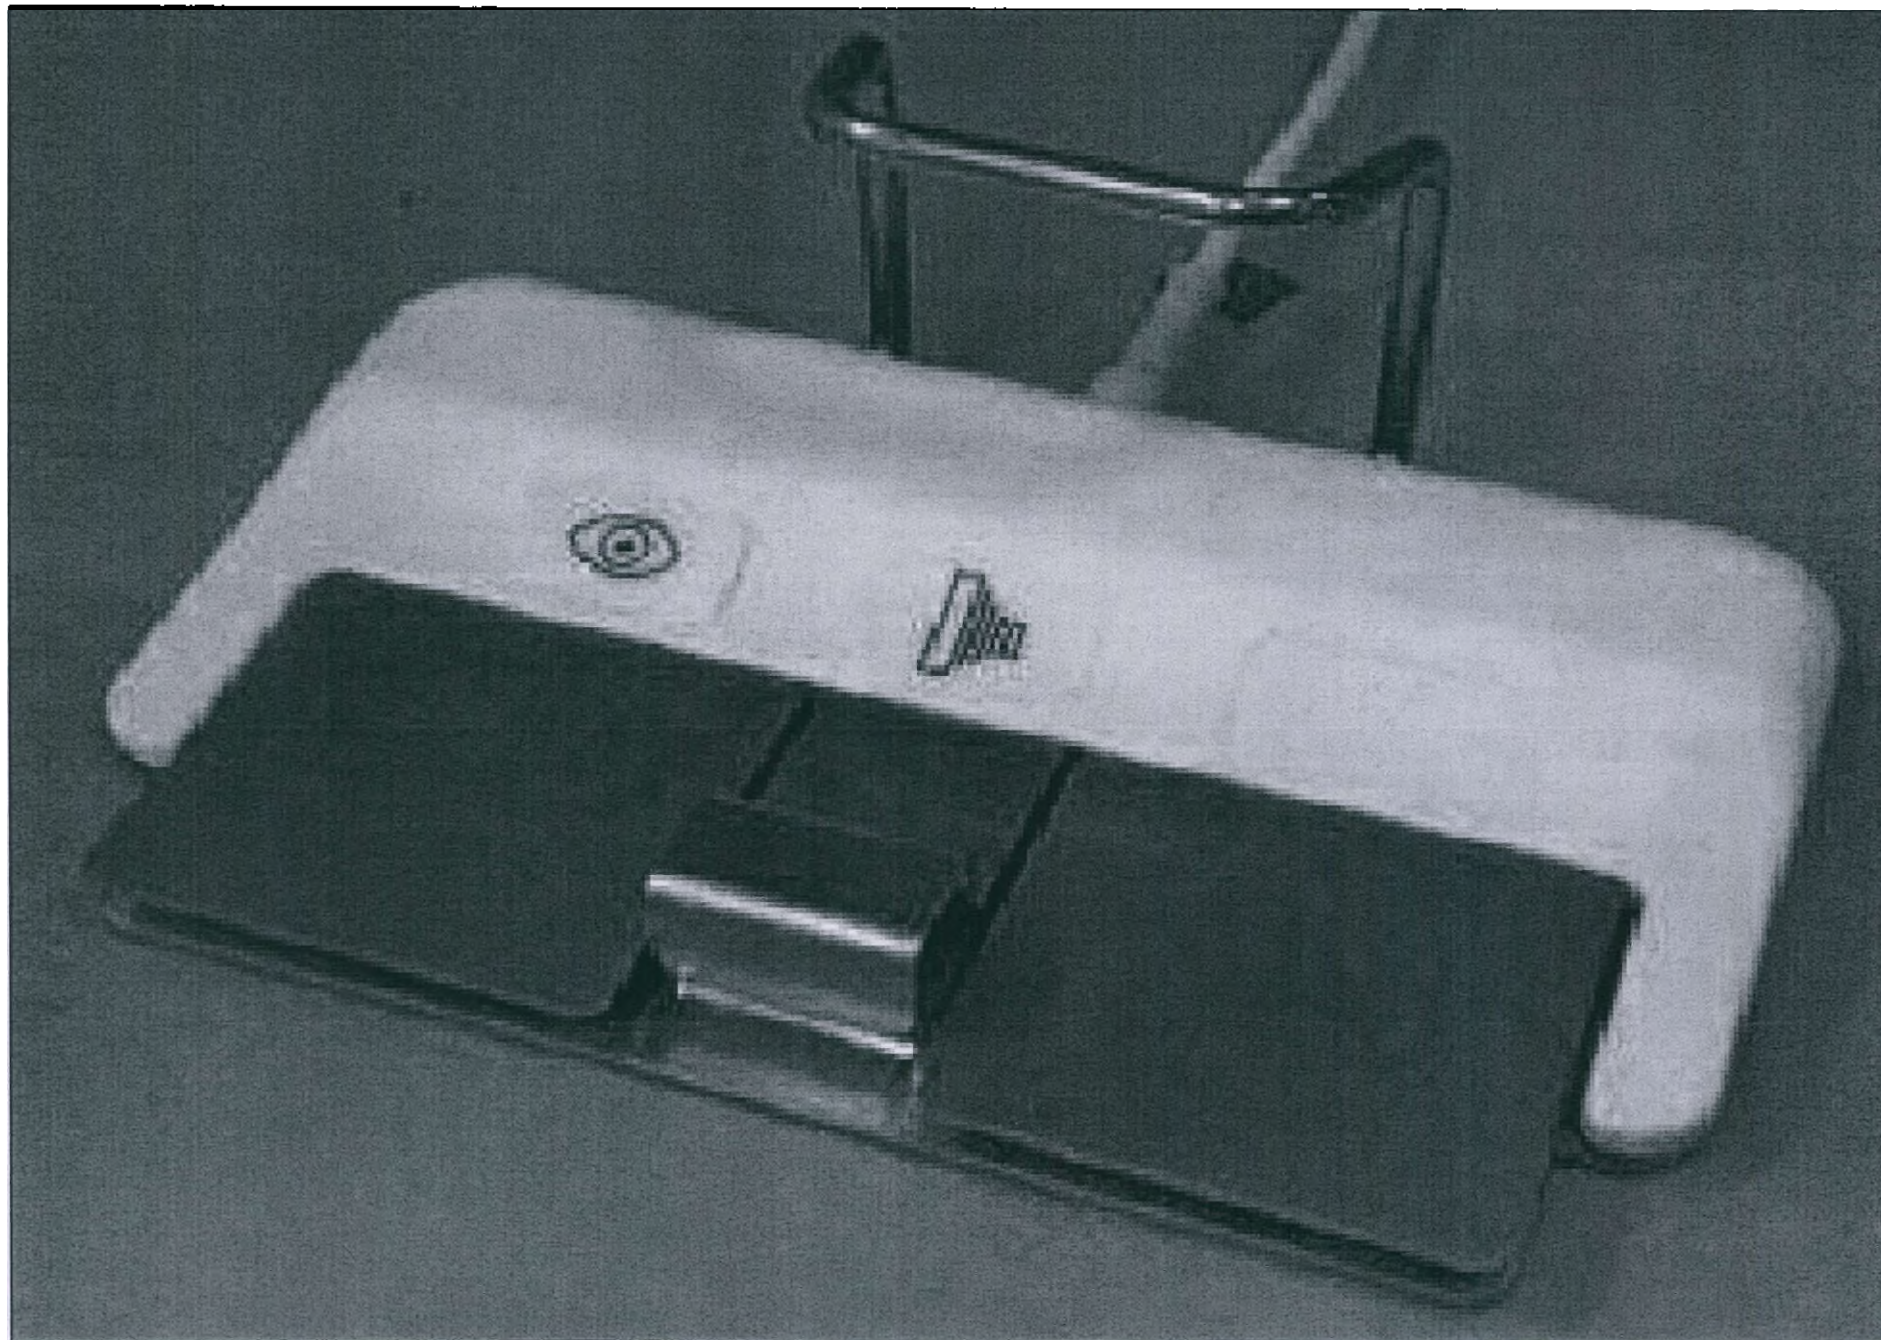


14. Ножной переключатель, не более 2 шт.

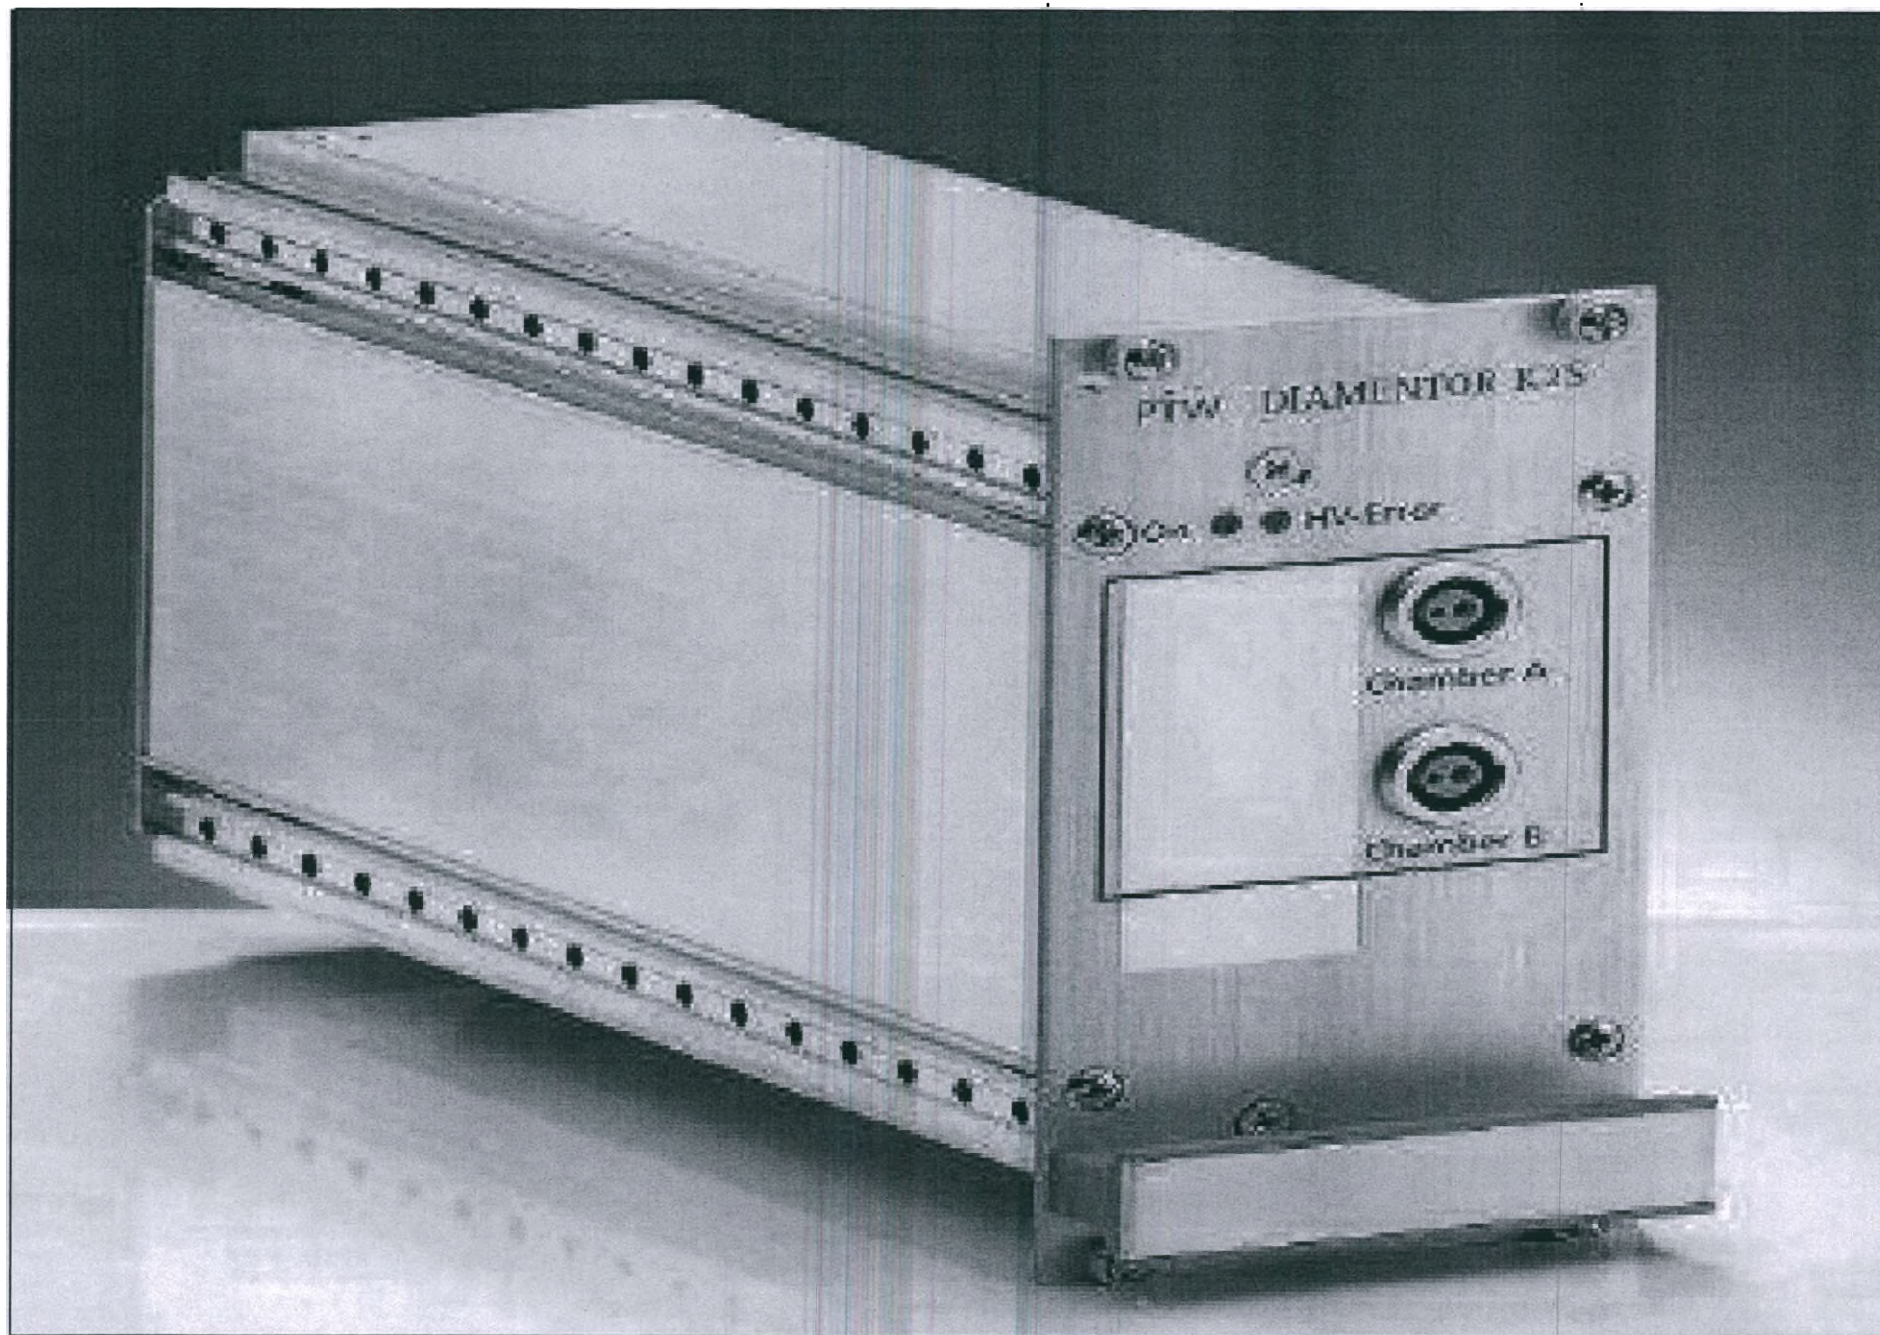


15.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

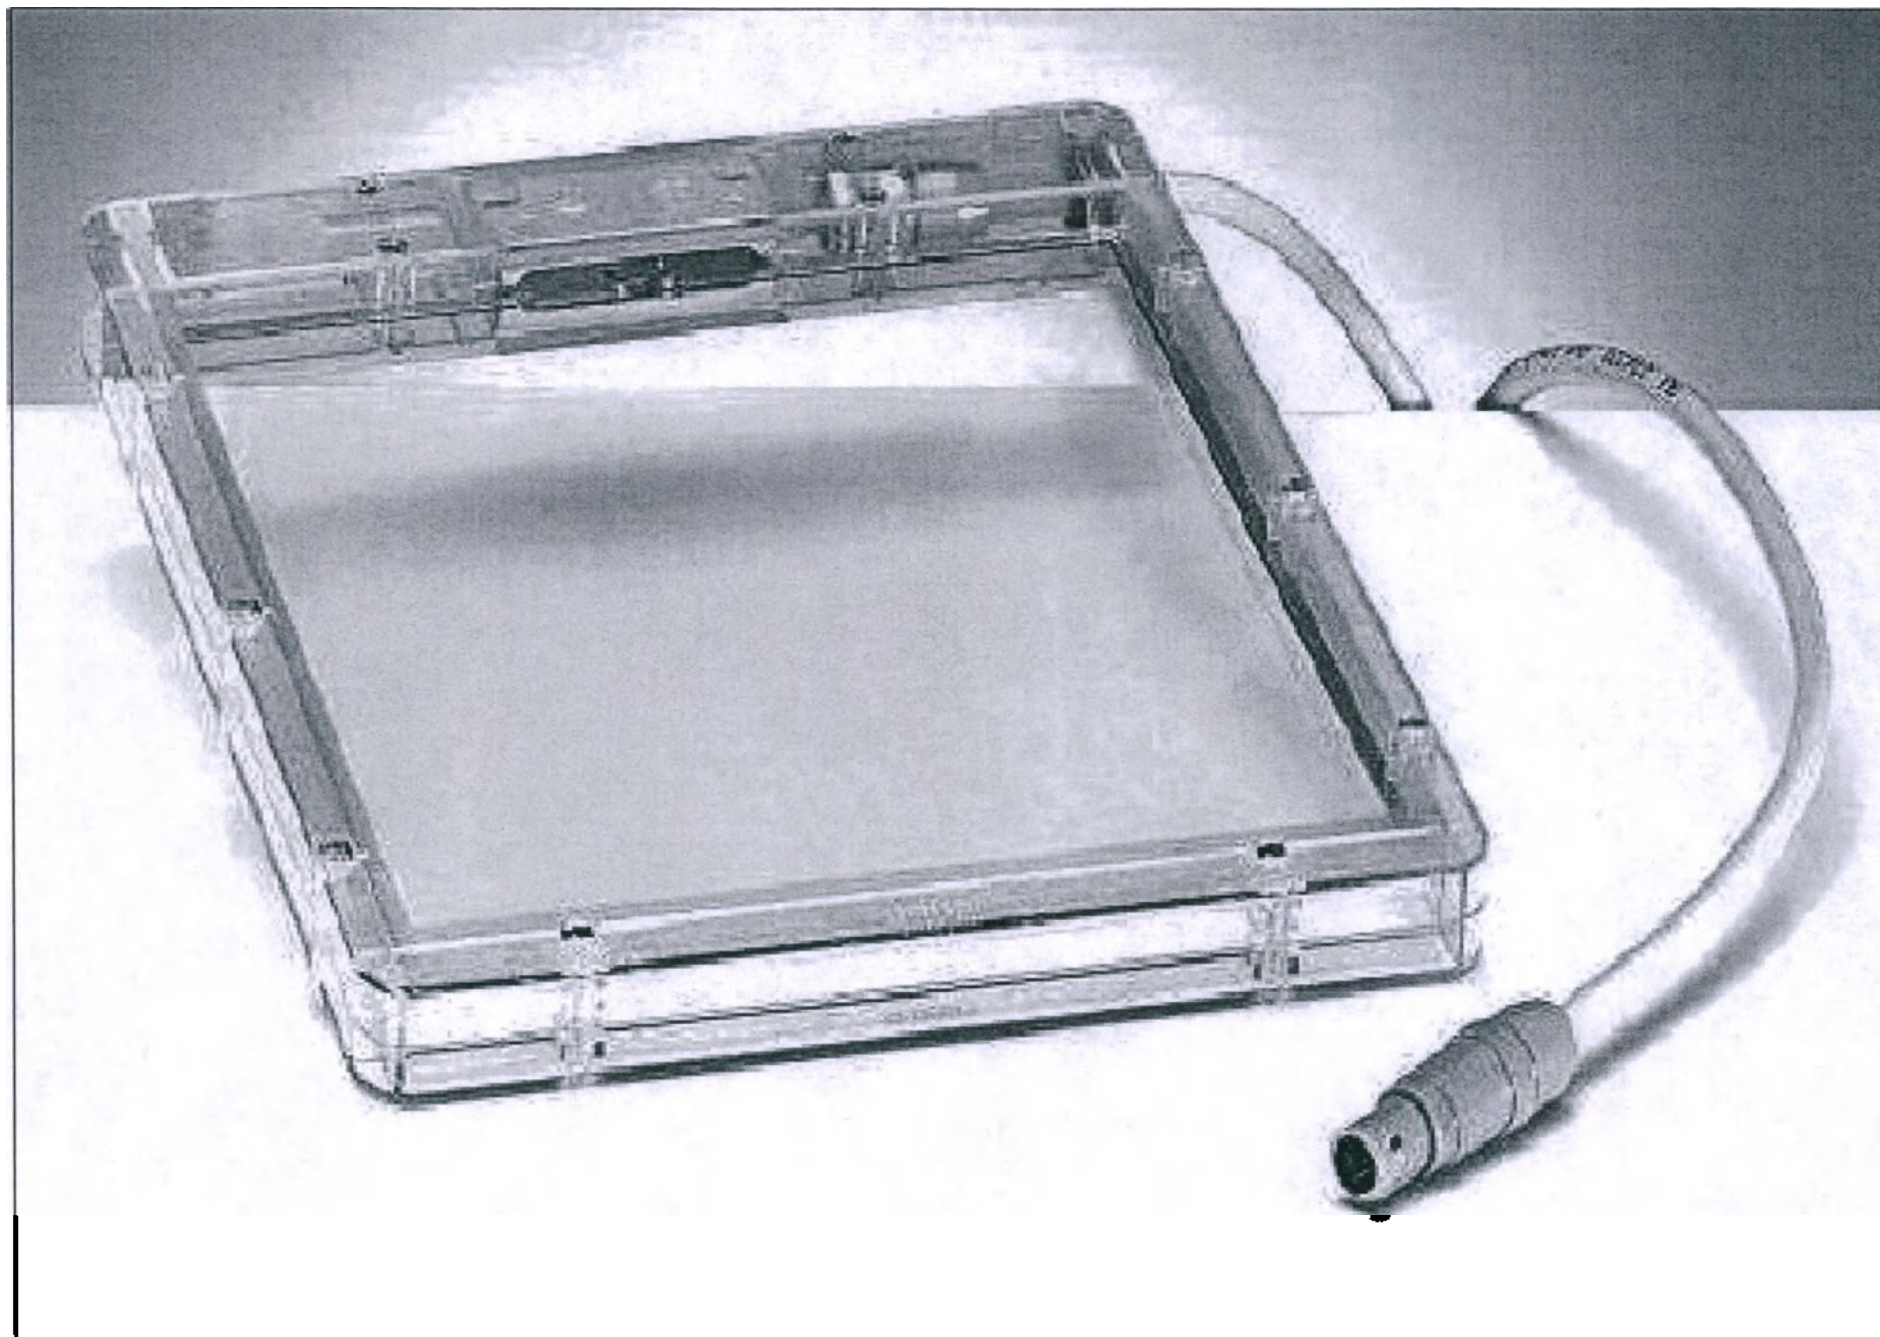


15.6. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДРК-1* или *ДРК-1М*.

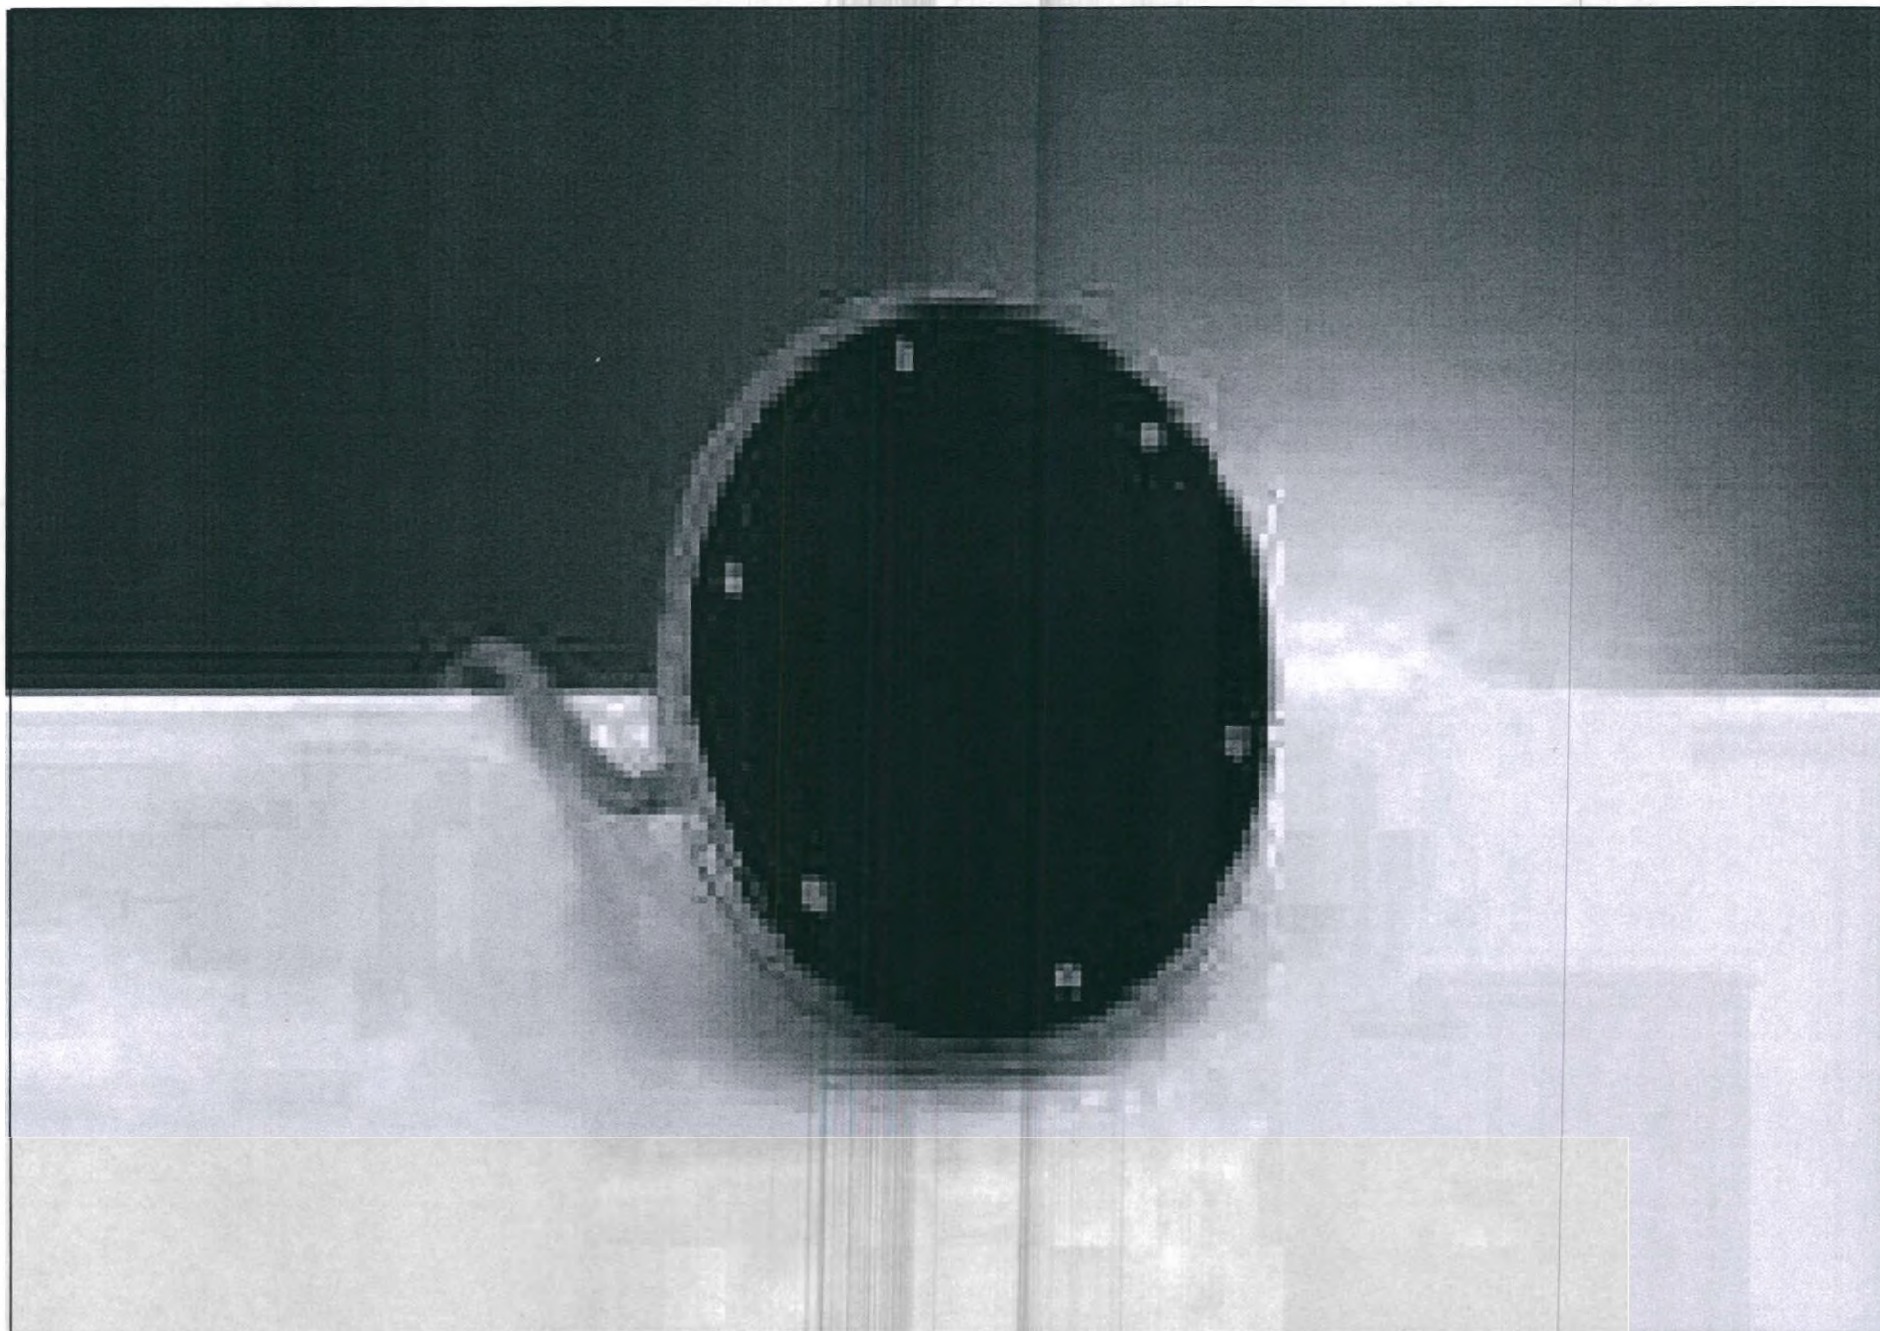


15.в. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

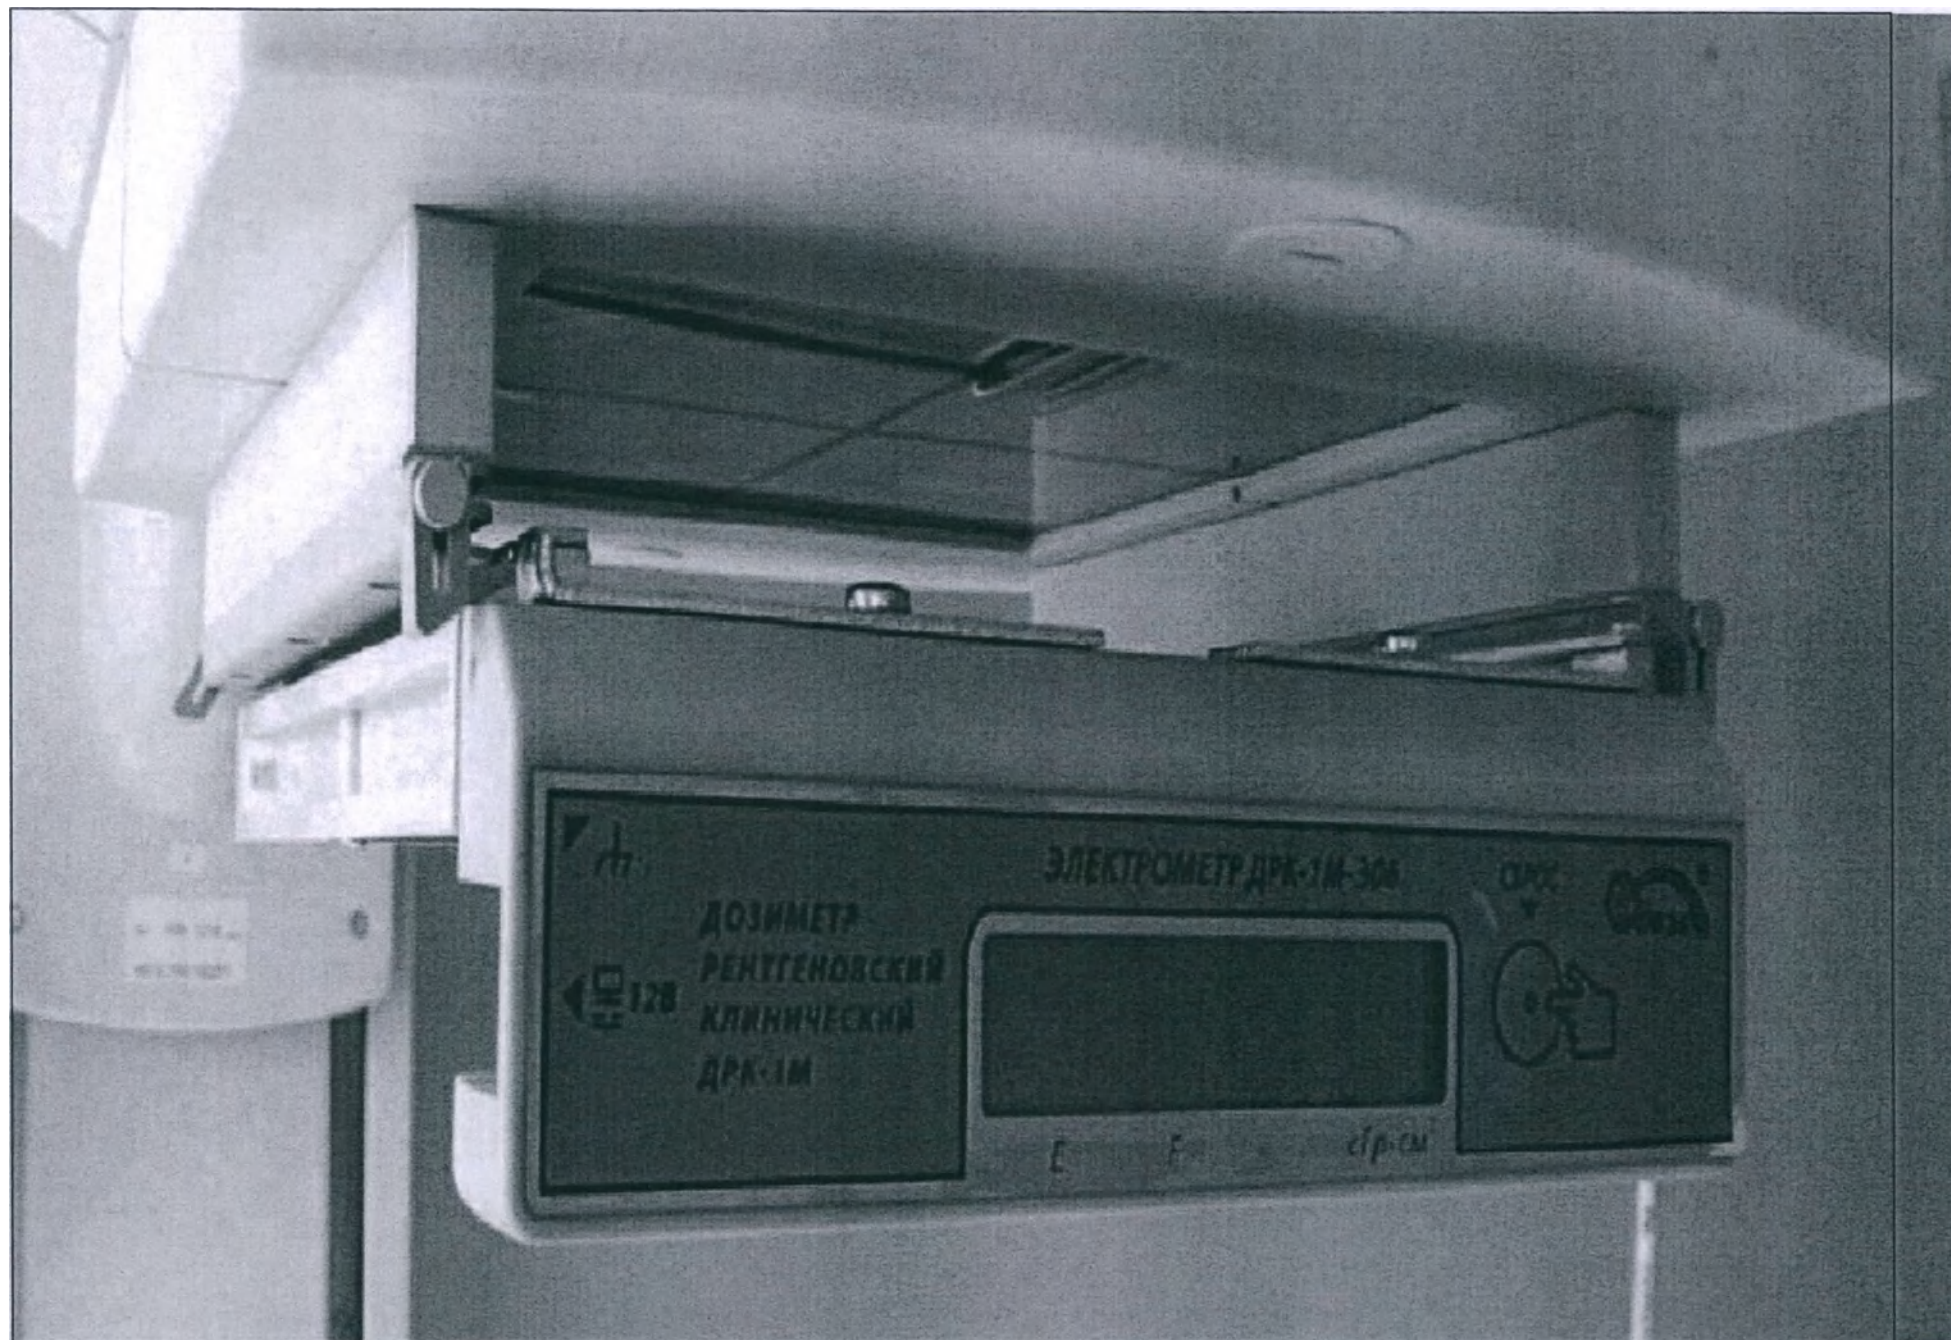


15.2. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

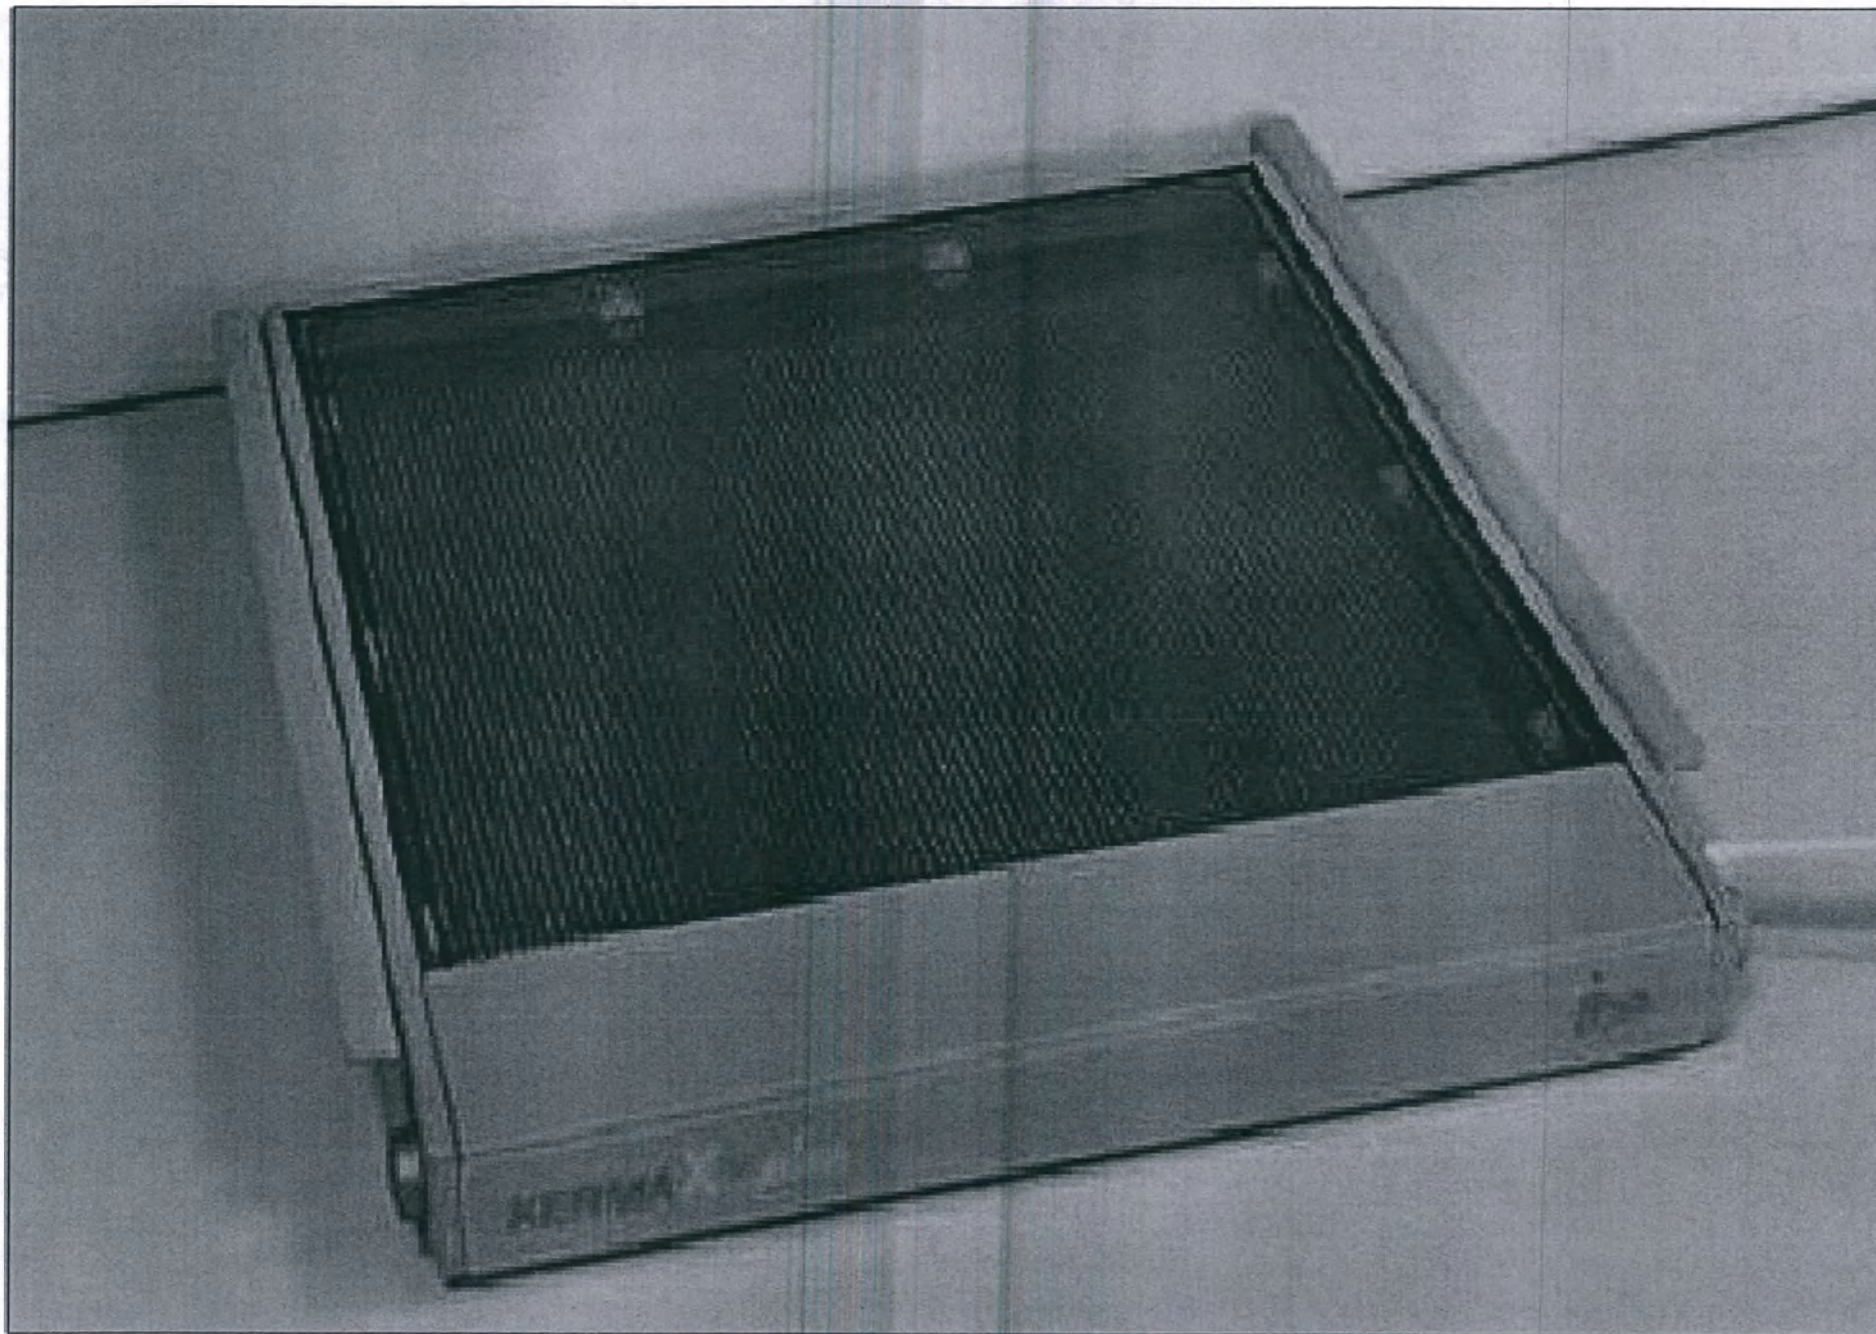


16. Измеритель производства дозы на площадь KermaX plus 120-132.

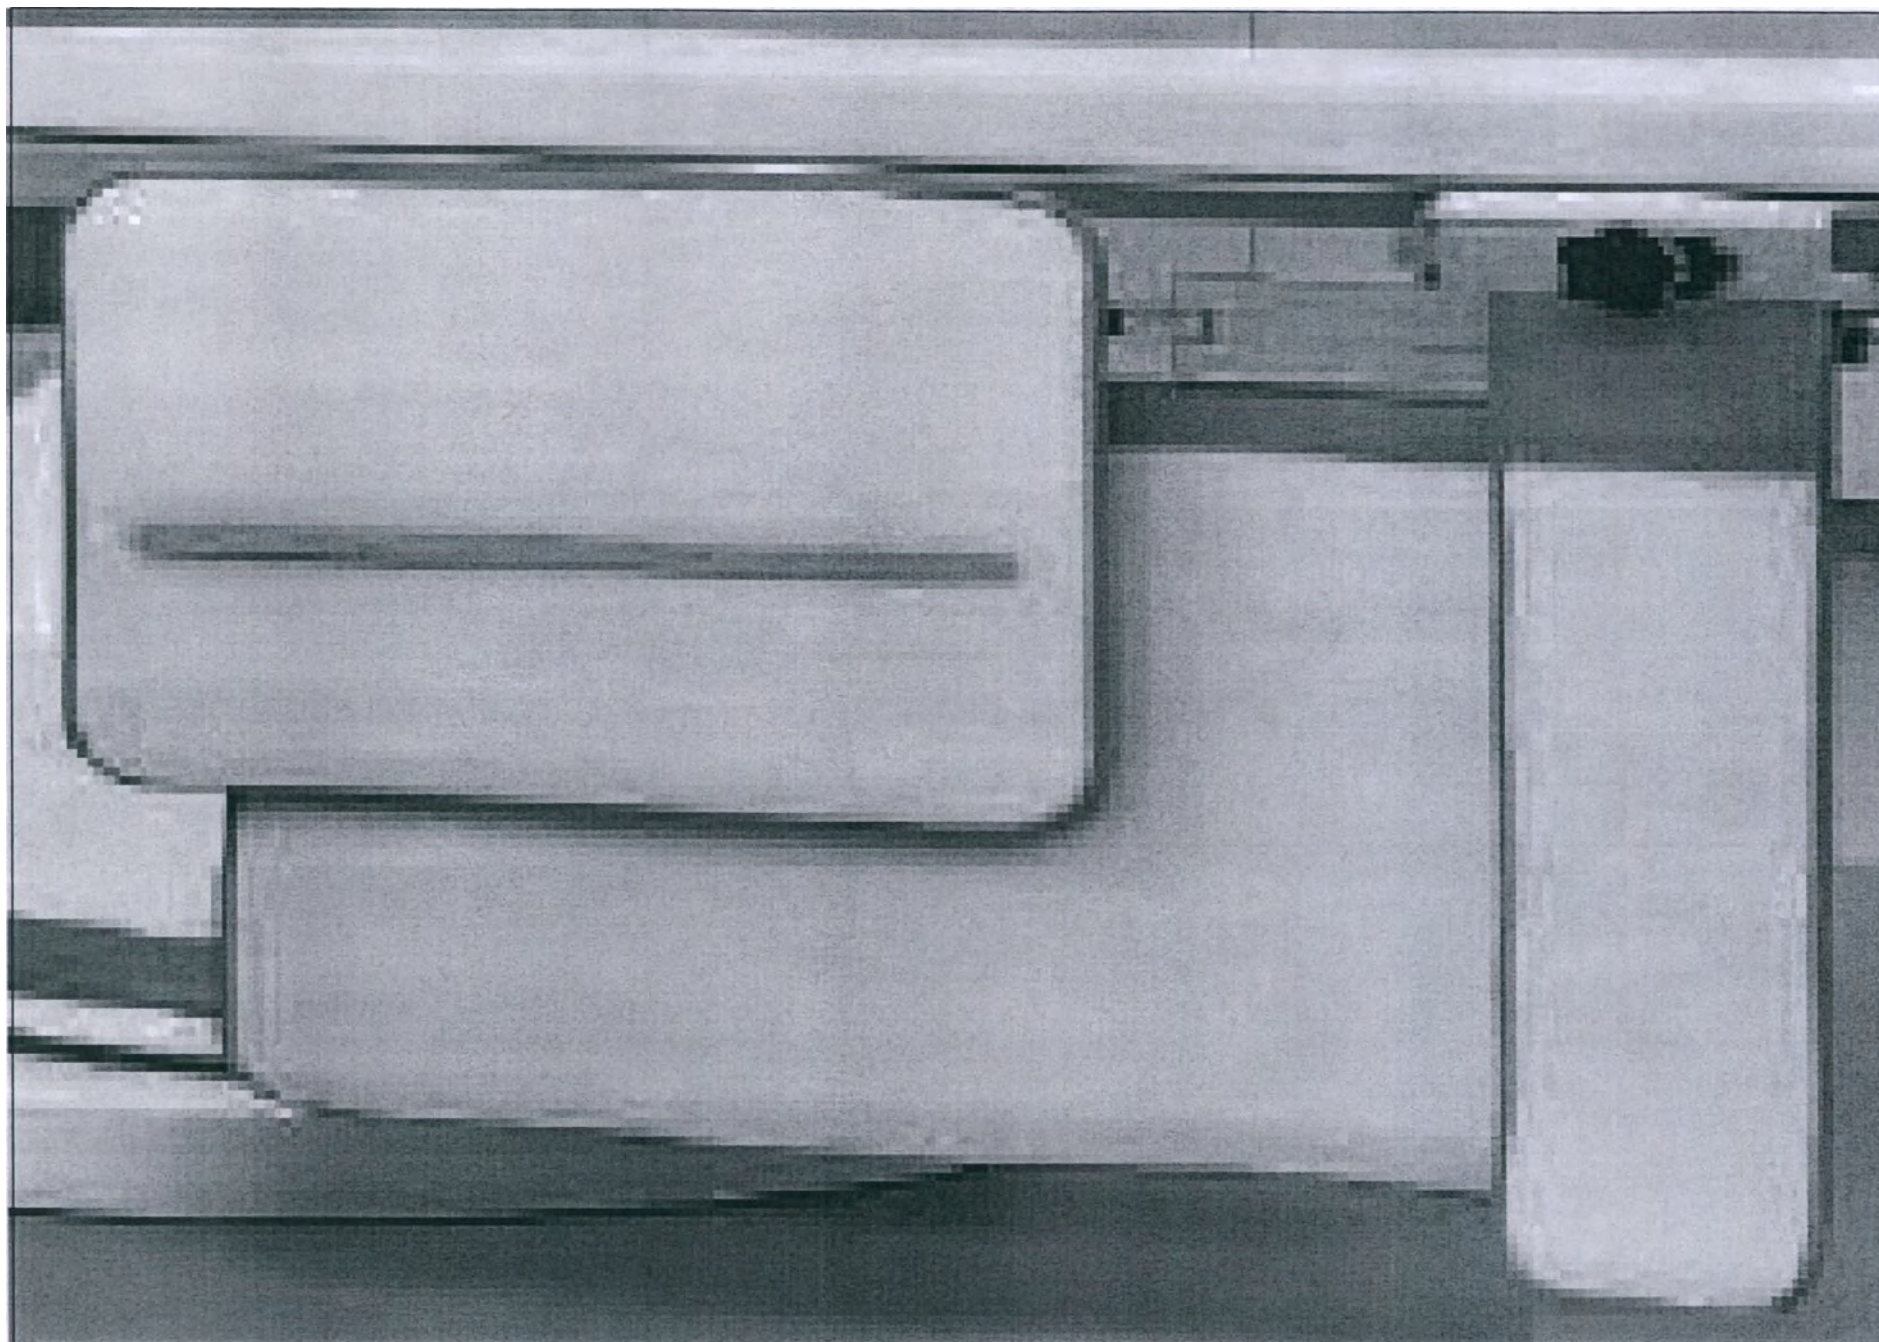


17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

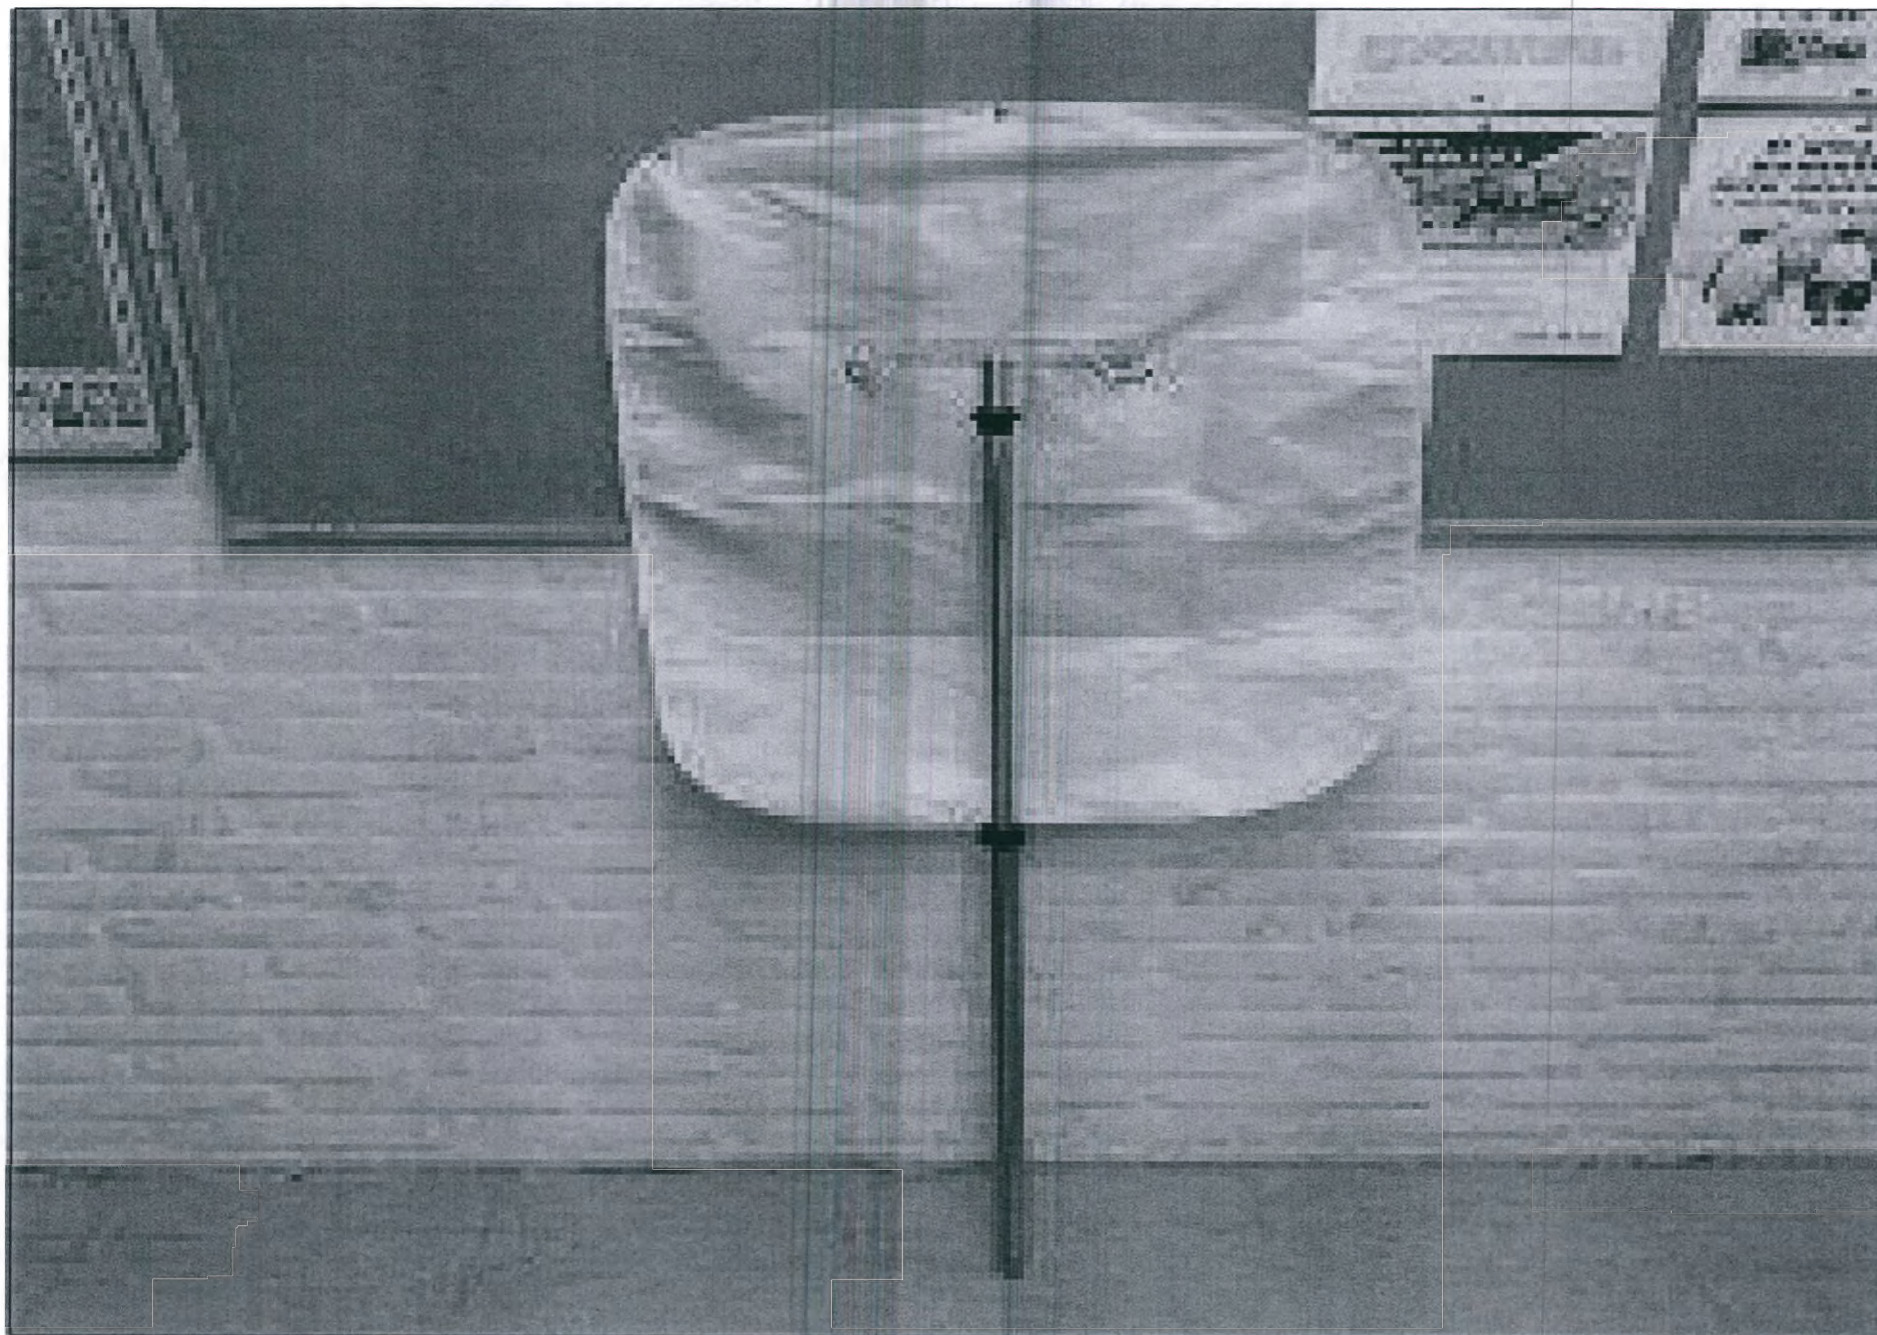


18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

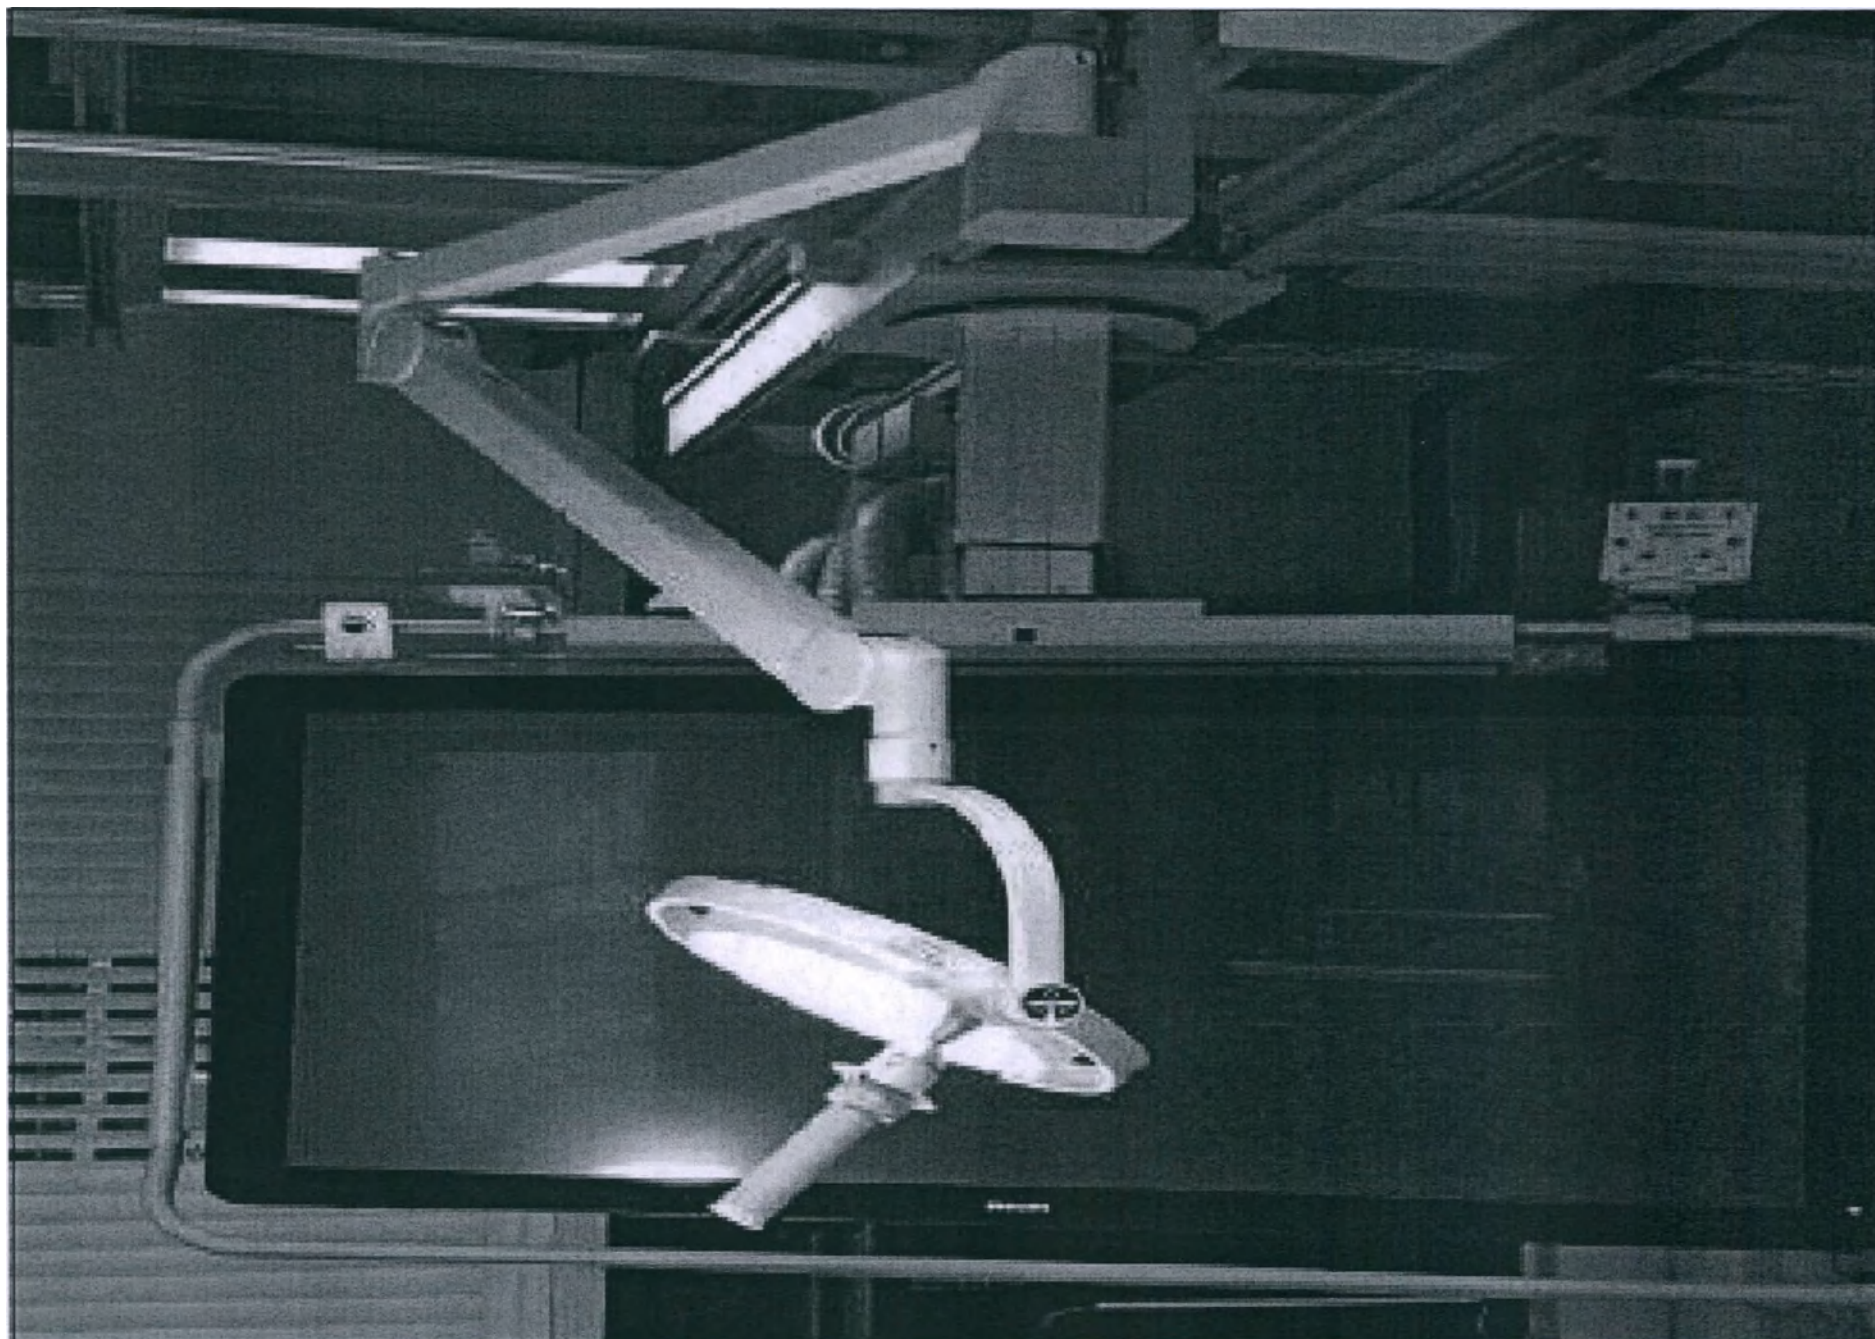

19. Лампа для осмотра

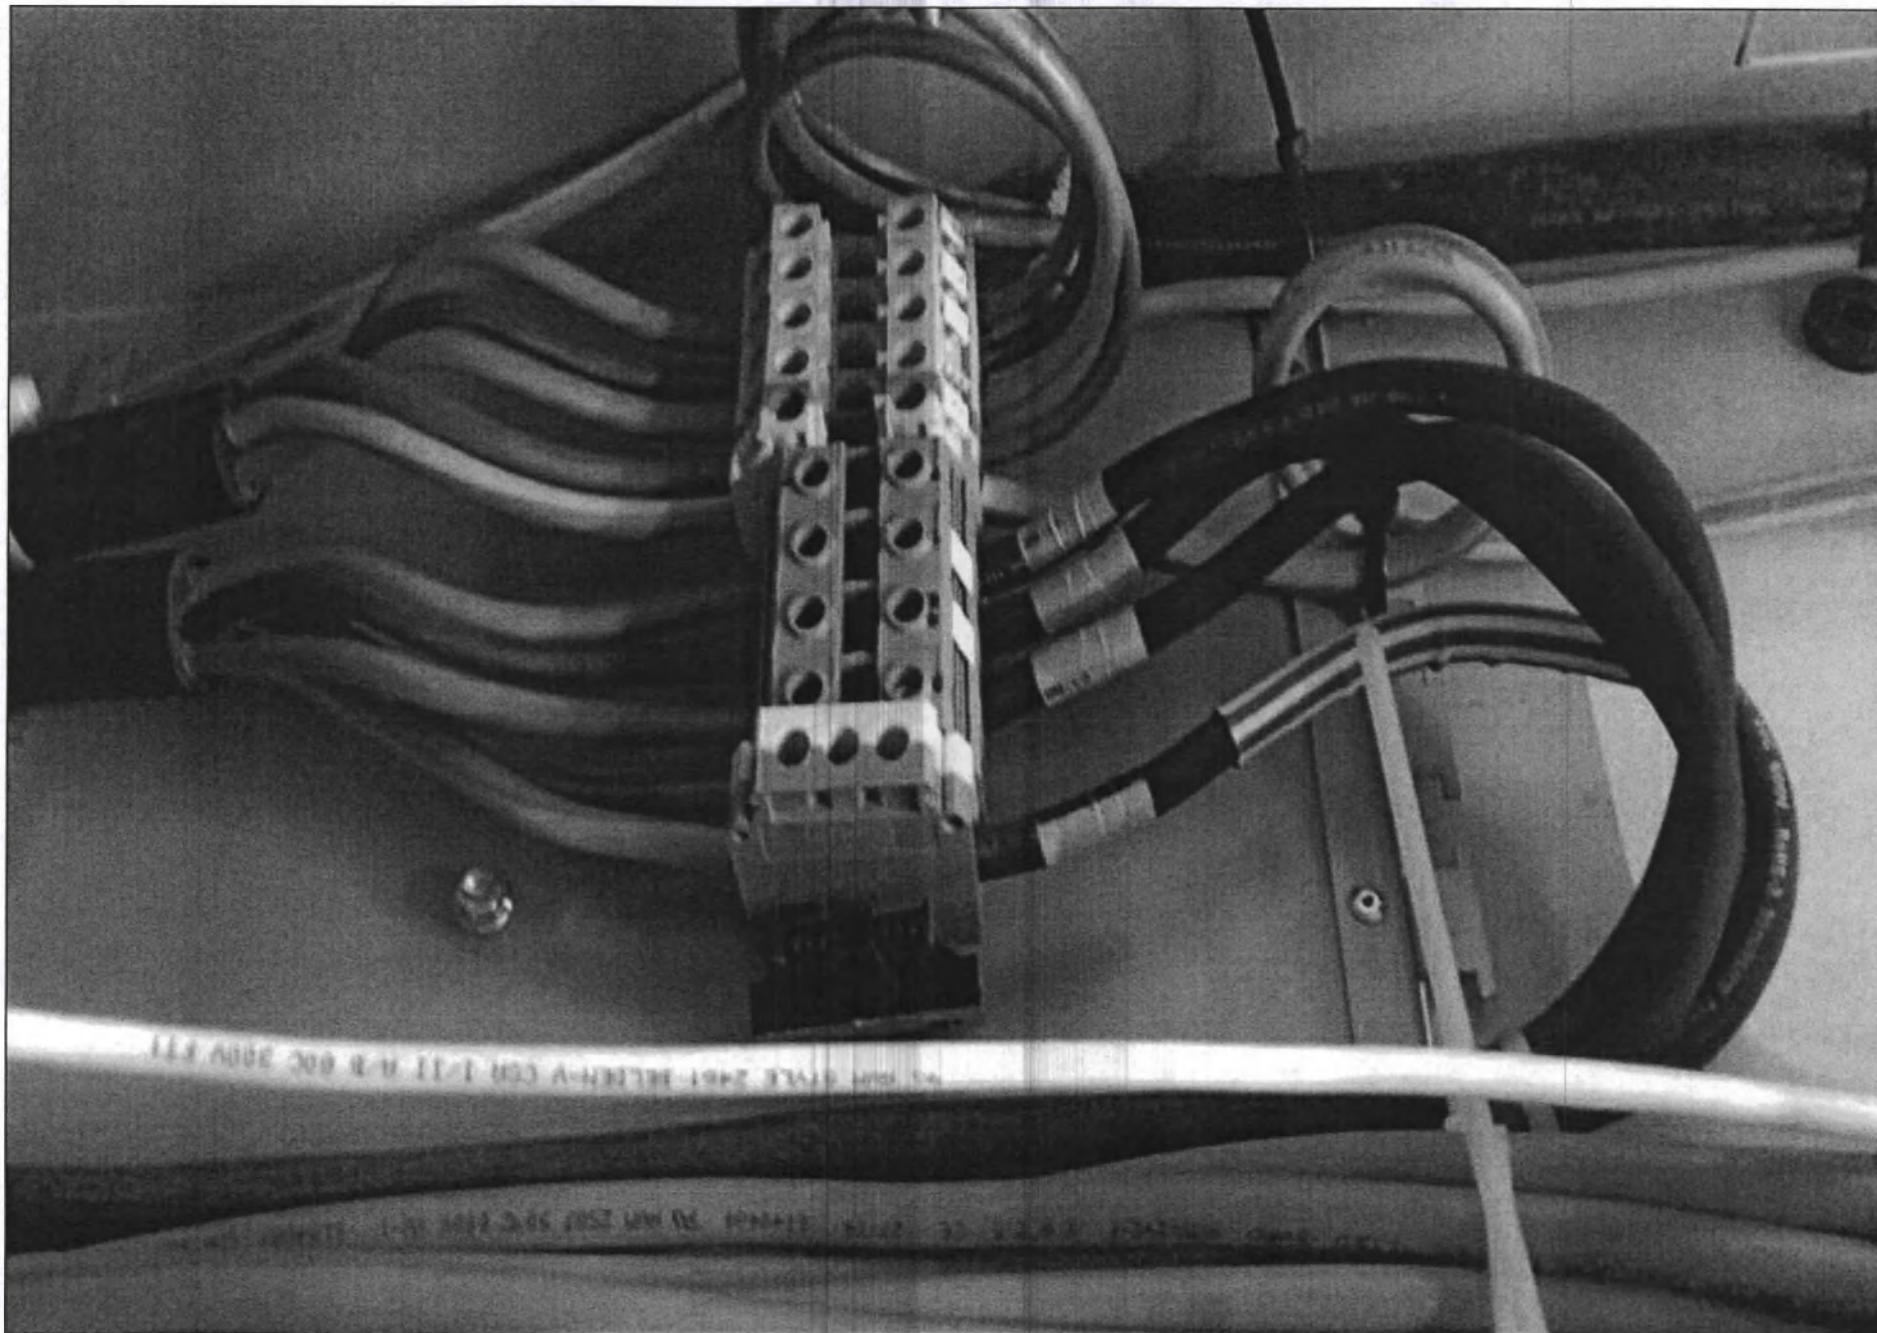

20. Кабели питания, 10 шт.

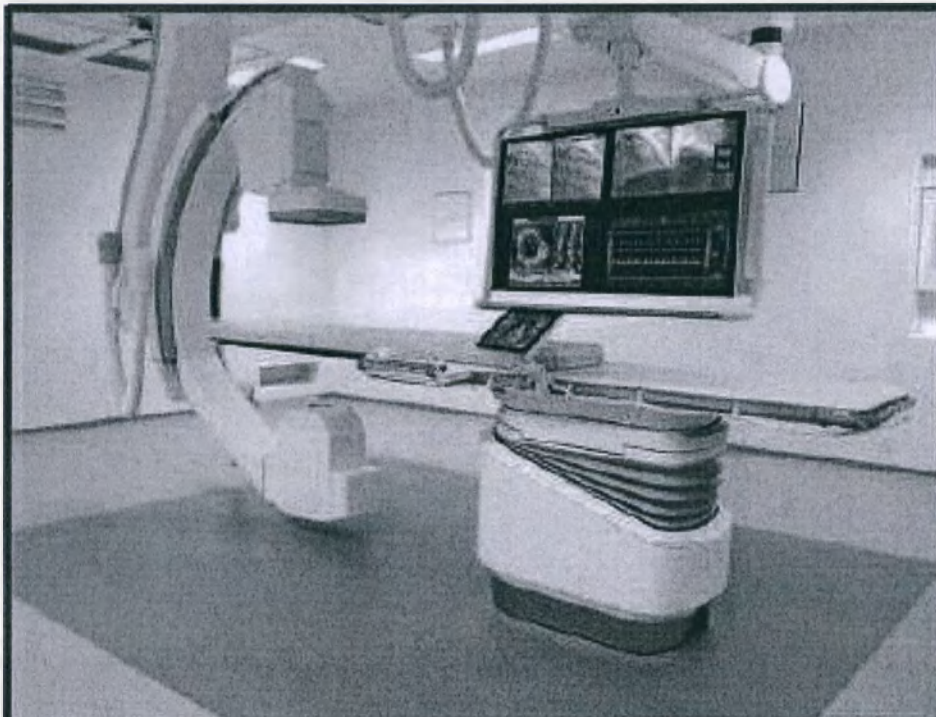

Руководство по
эксплуатации

Русский


4522 203 52651

Azurion

Версия 1.2

PHILIPS

21.б. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.

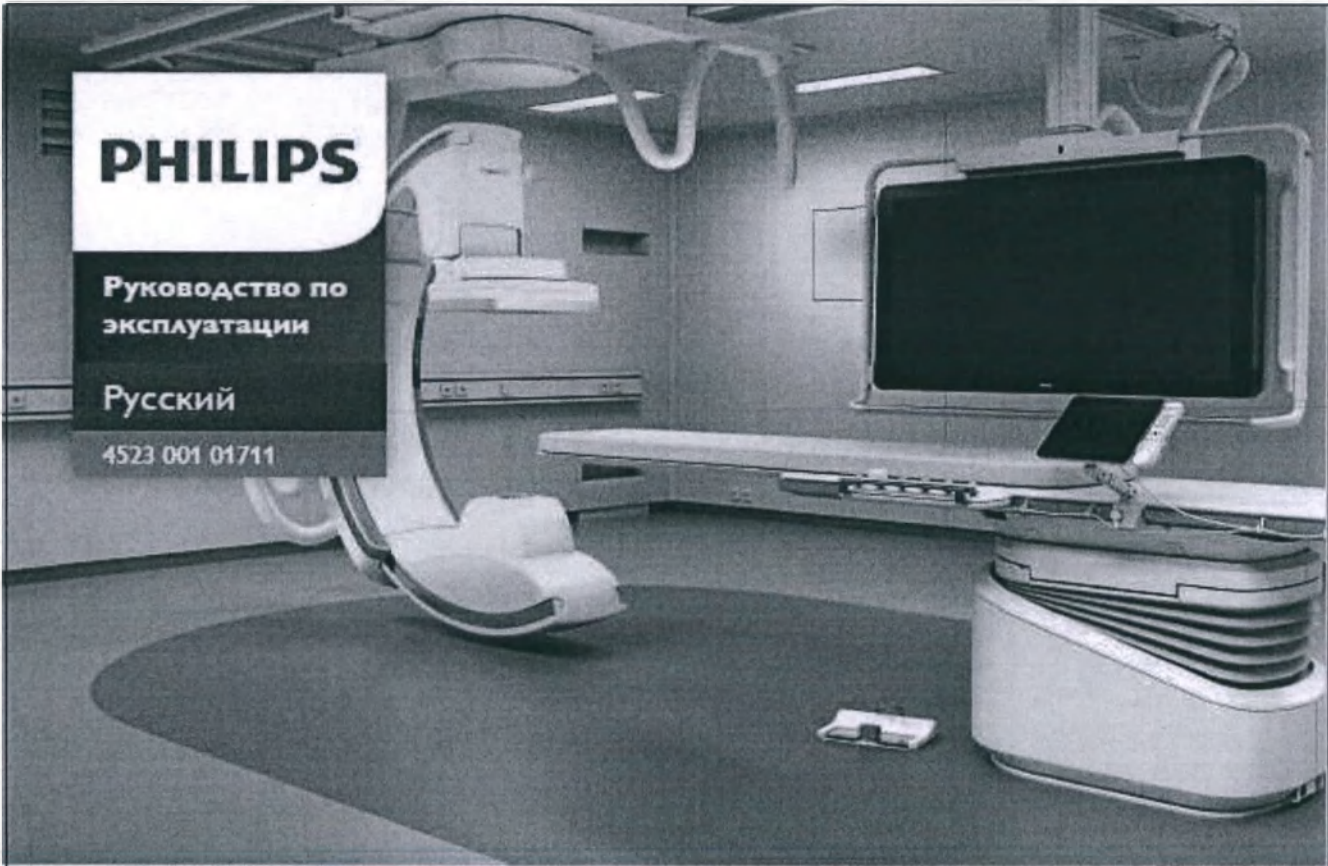

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский


4523 001 01711

Philips Azurion


Версия 2.2

21.в. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 7 M12 (вариант 1):

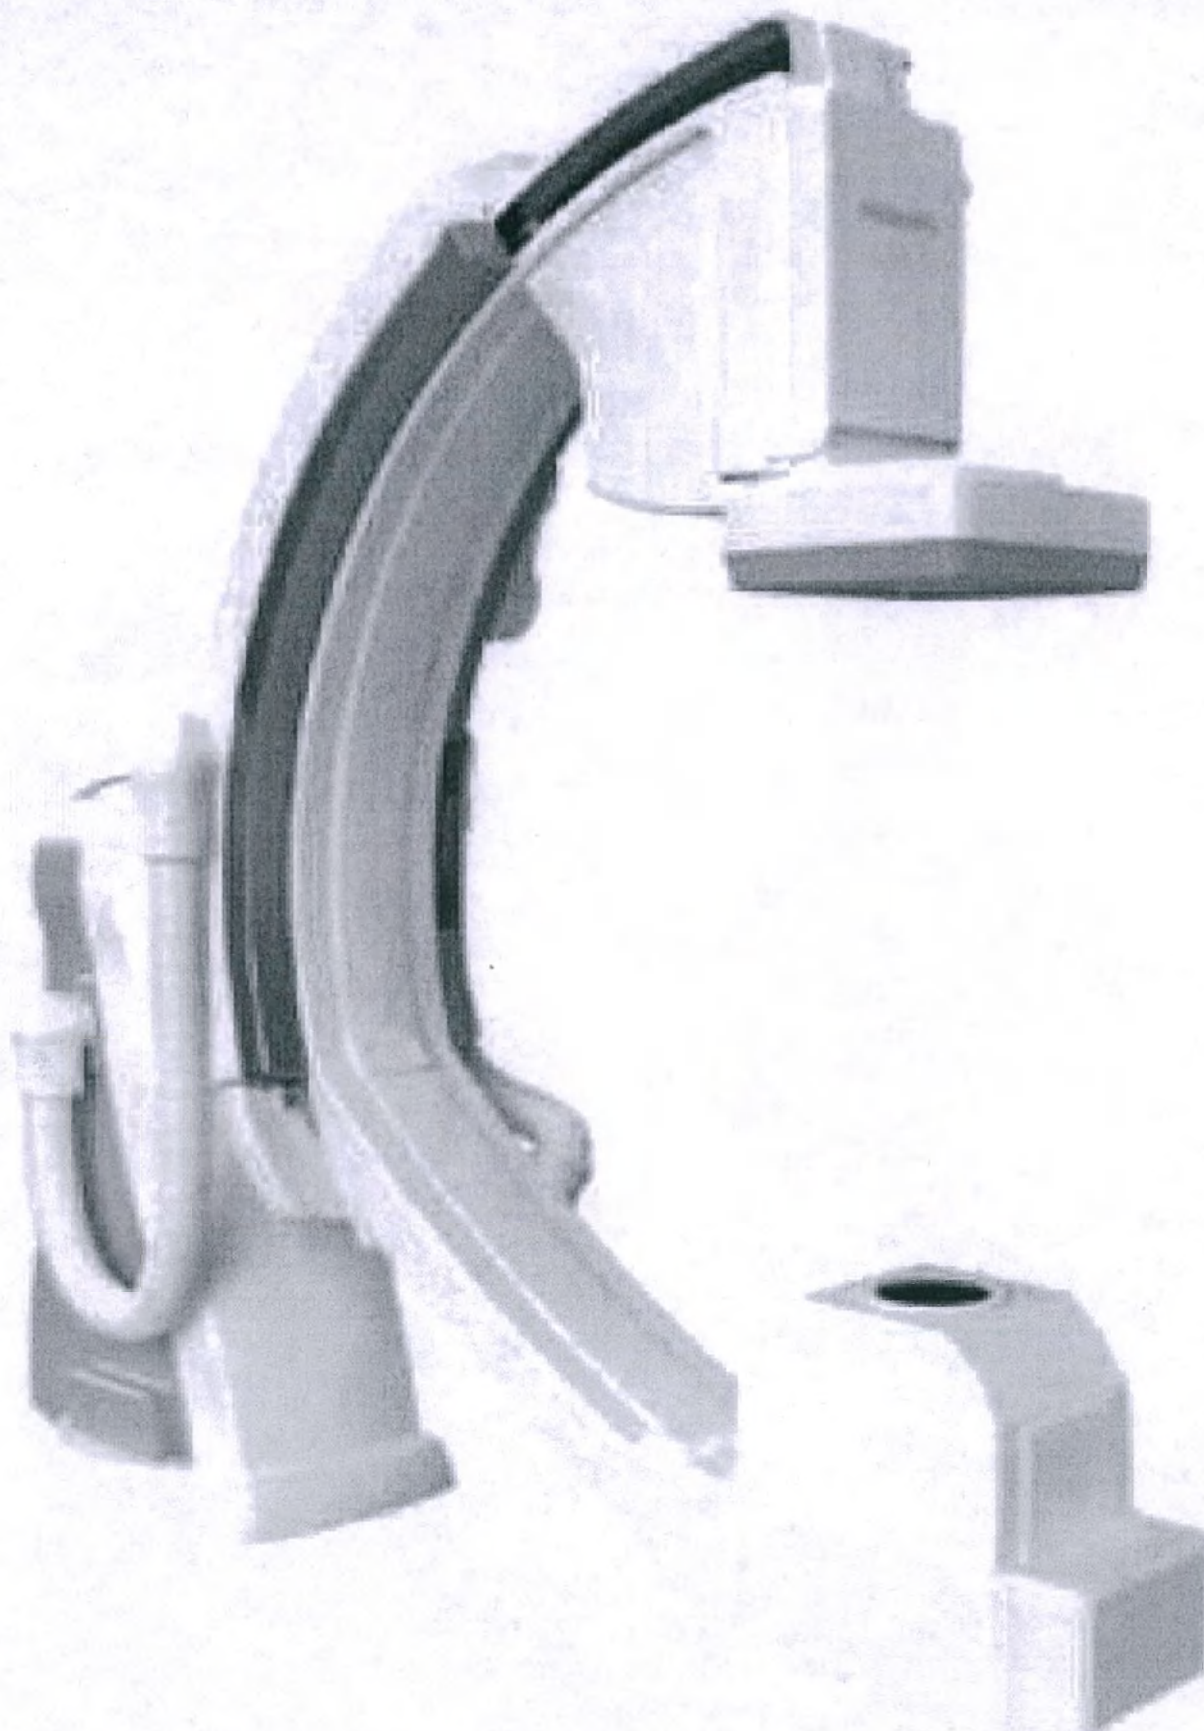


1. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

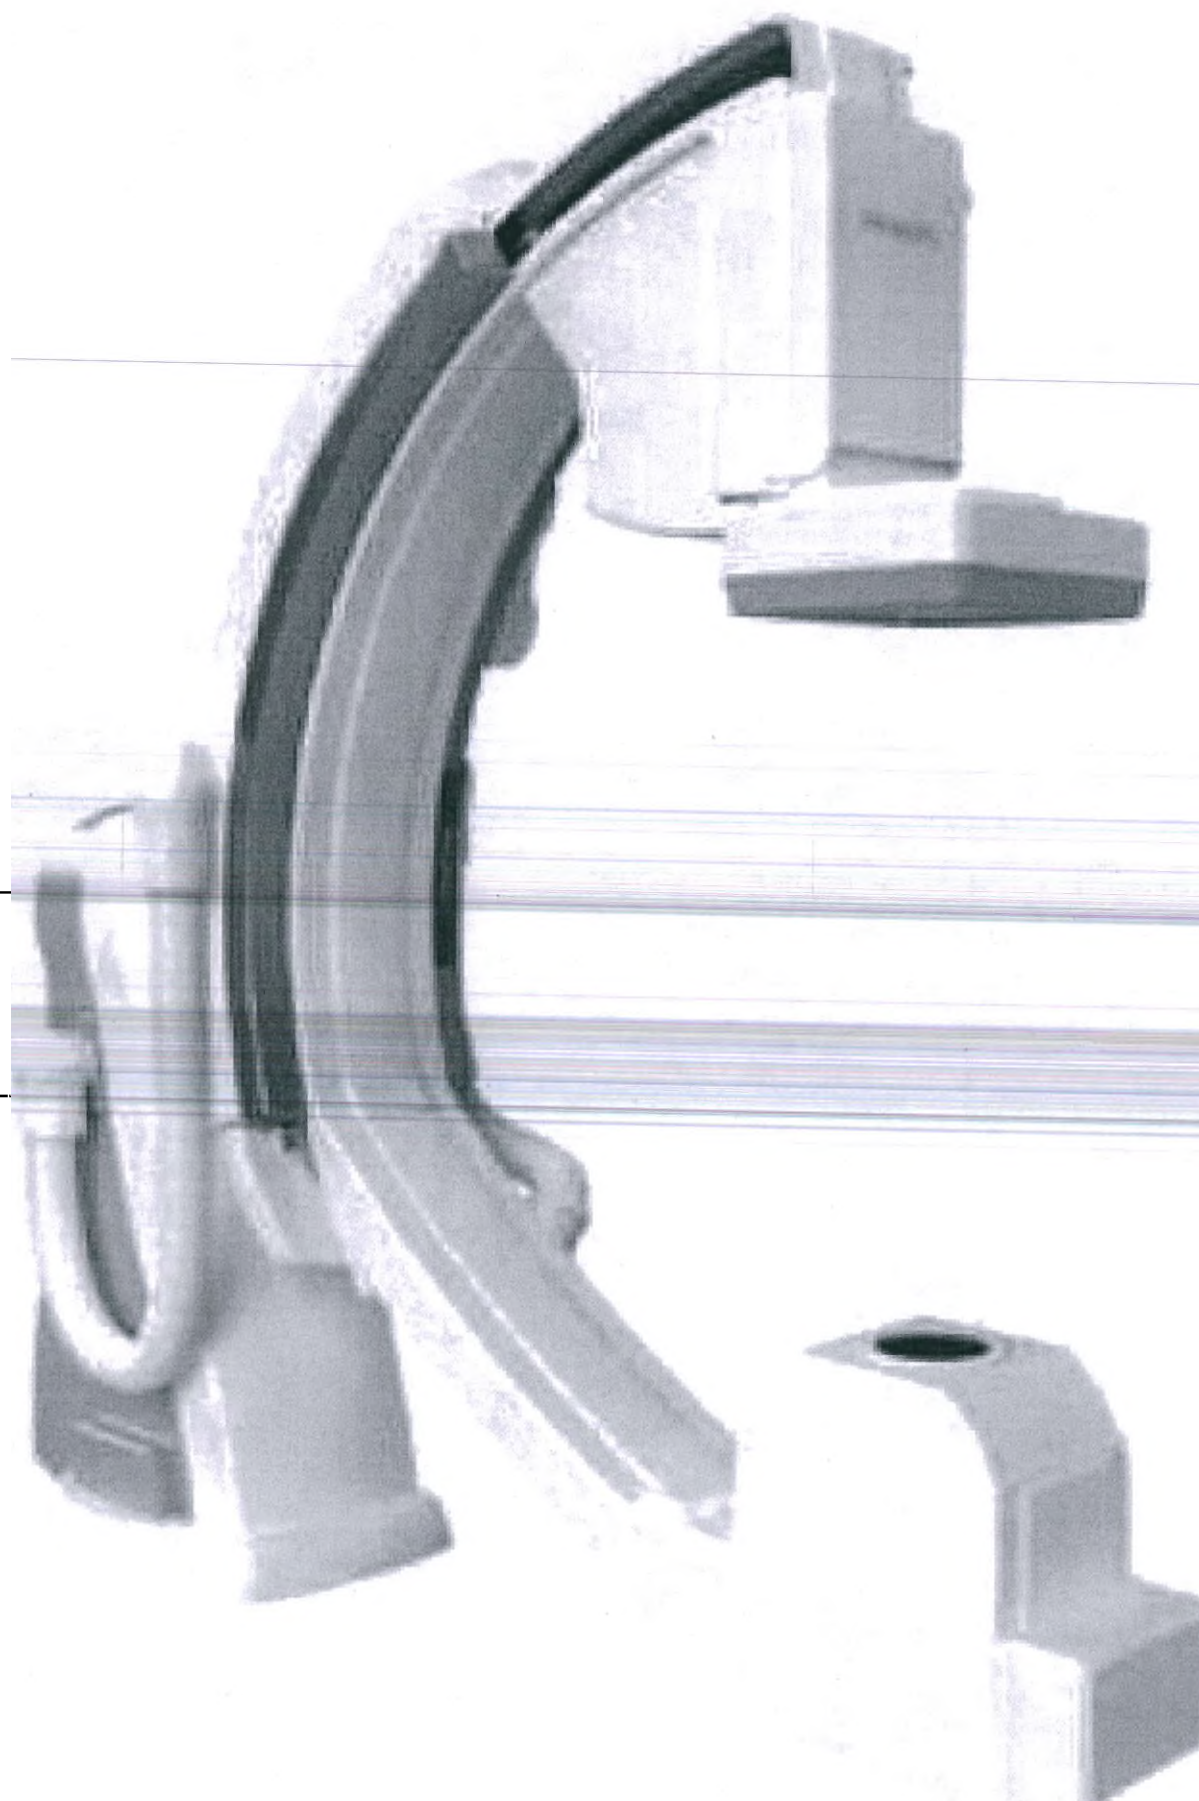


1.а. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

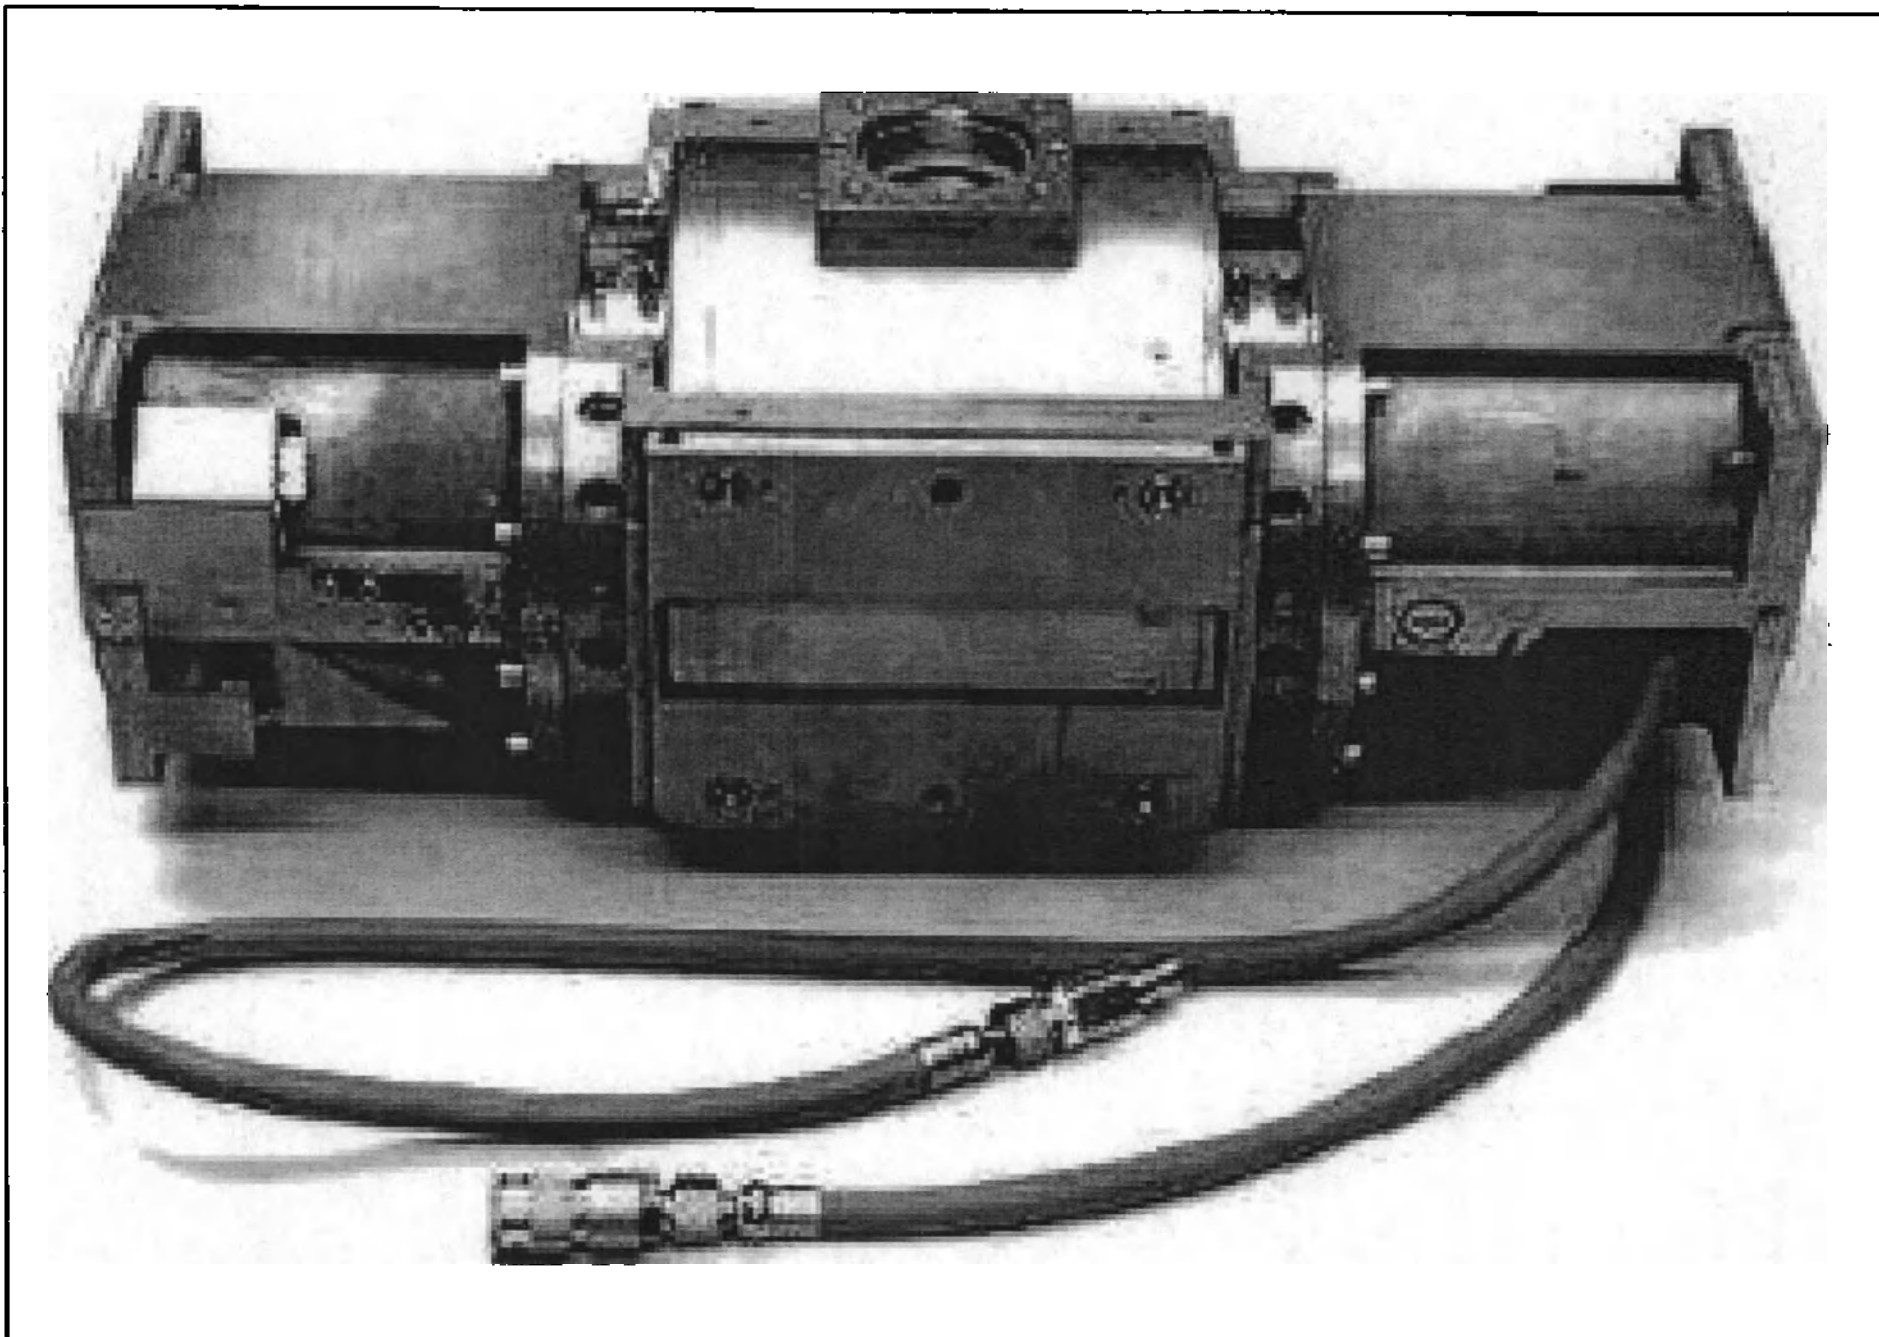


1.6. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

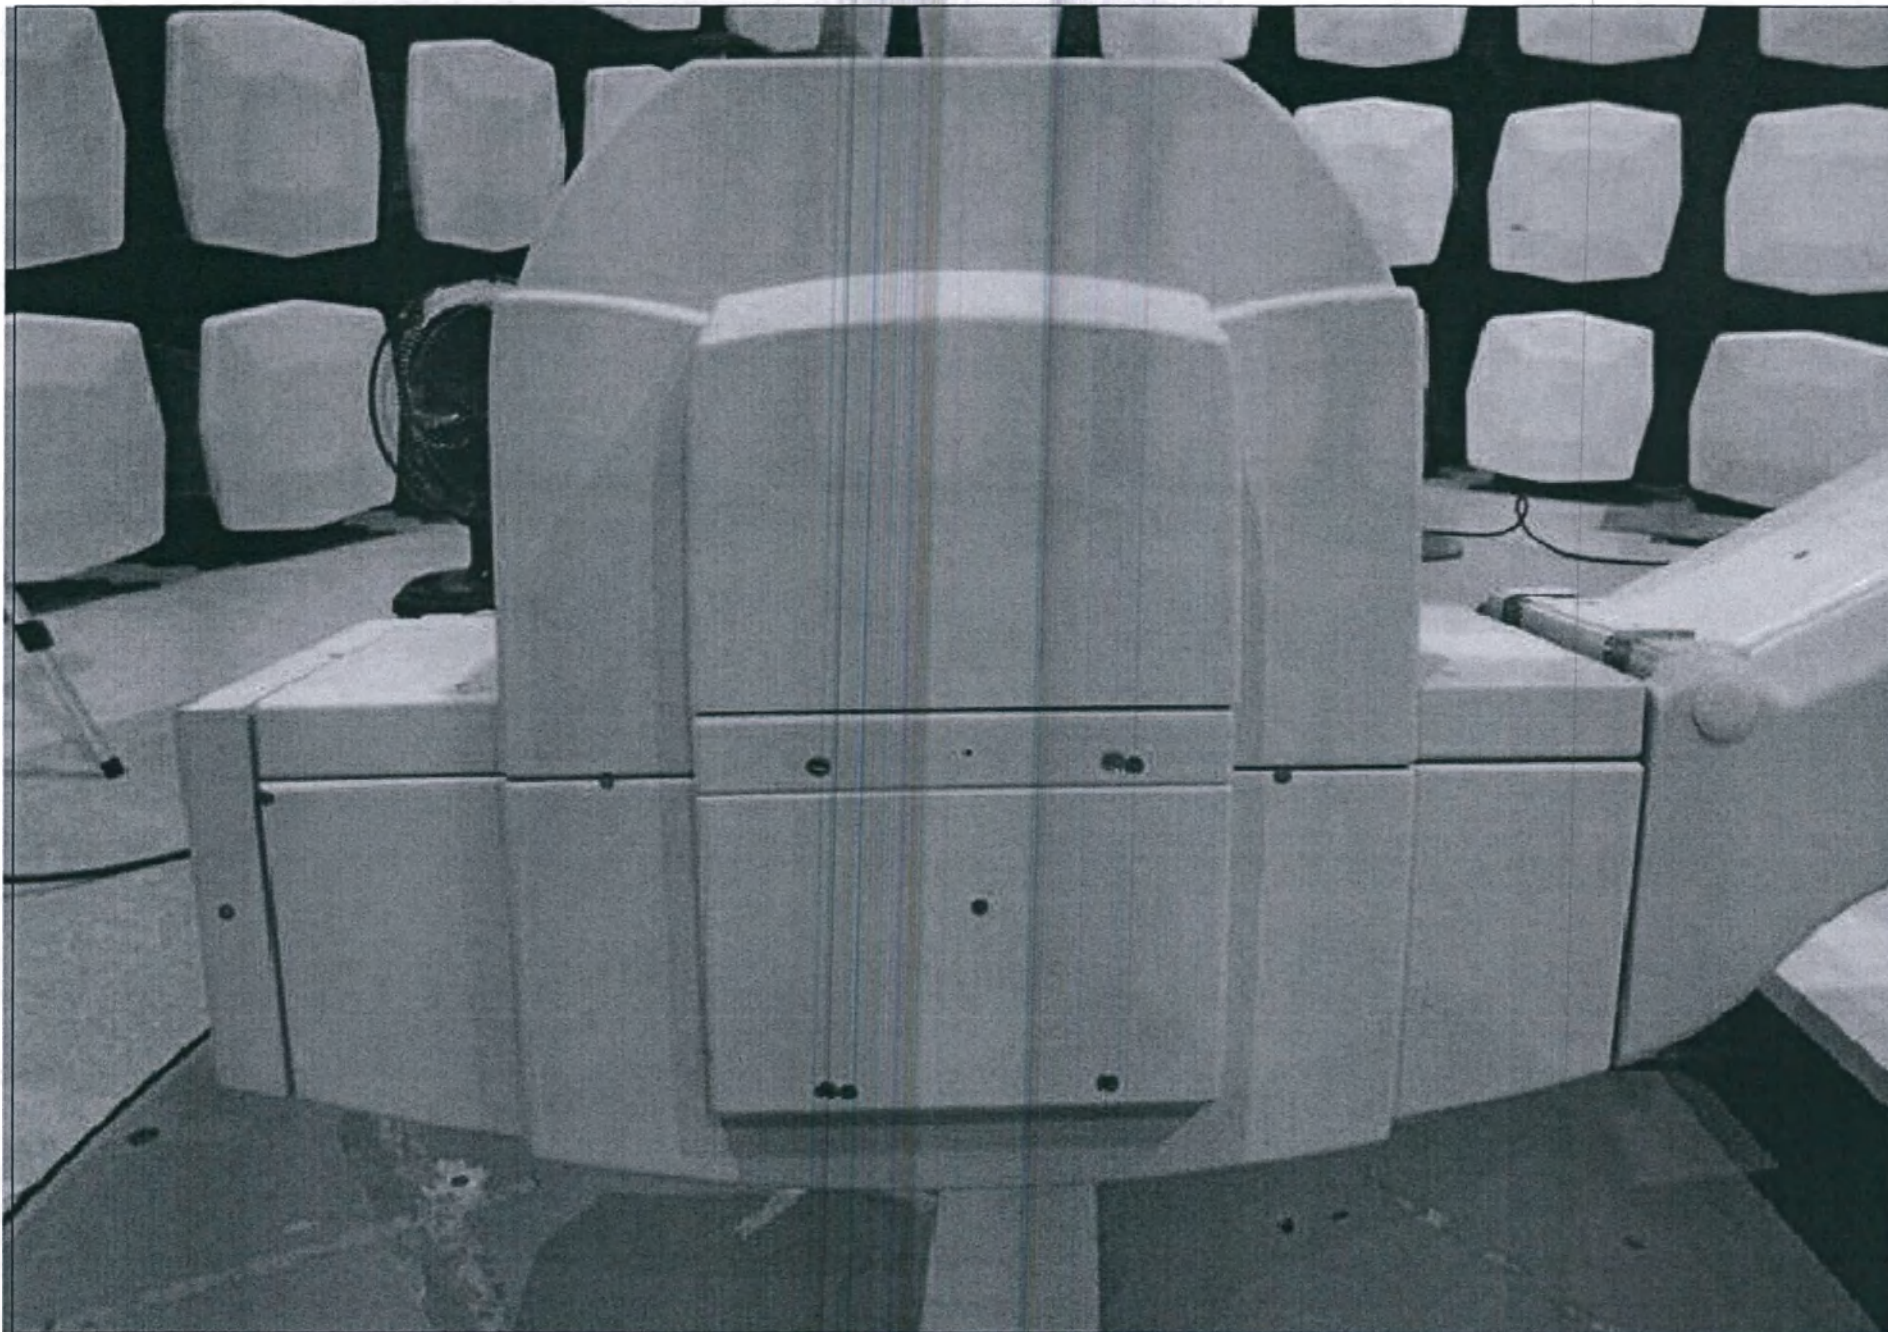


1.в. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

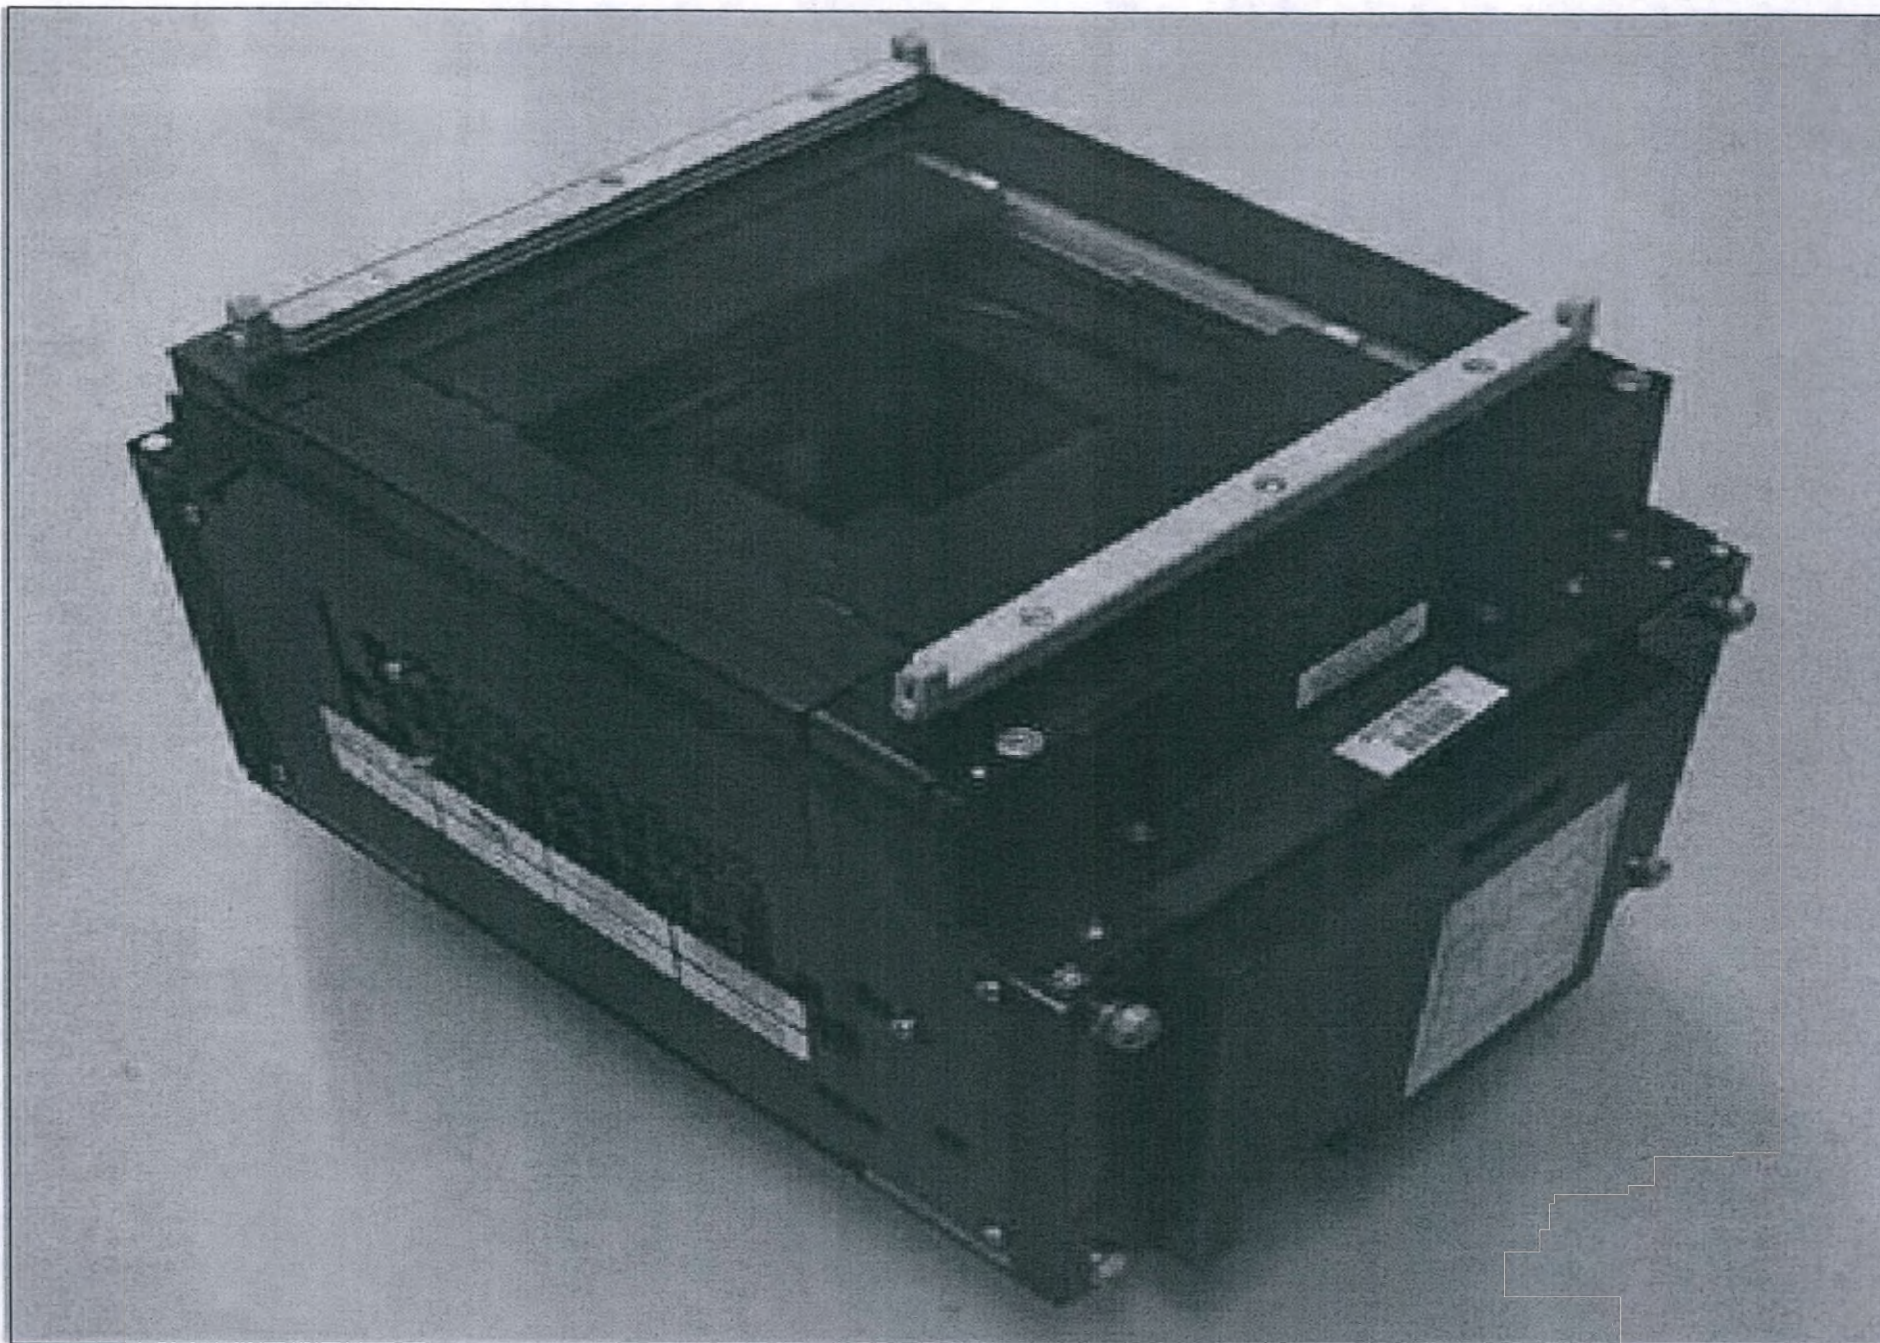


1.2. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

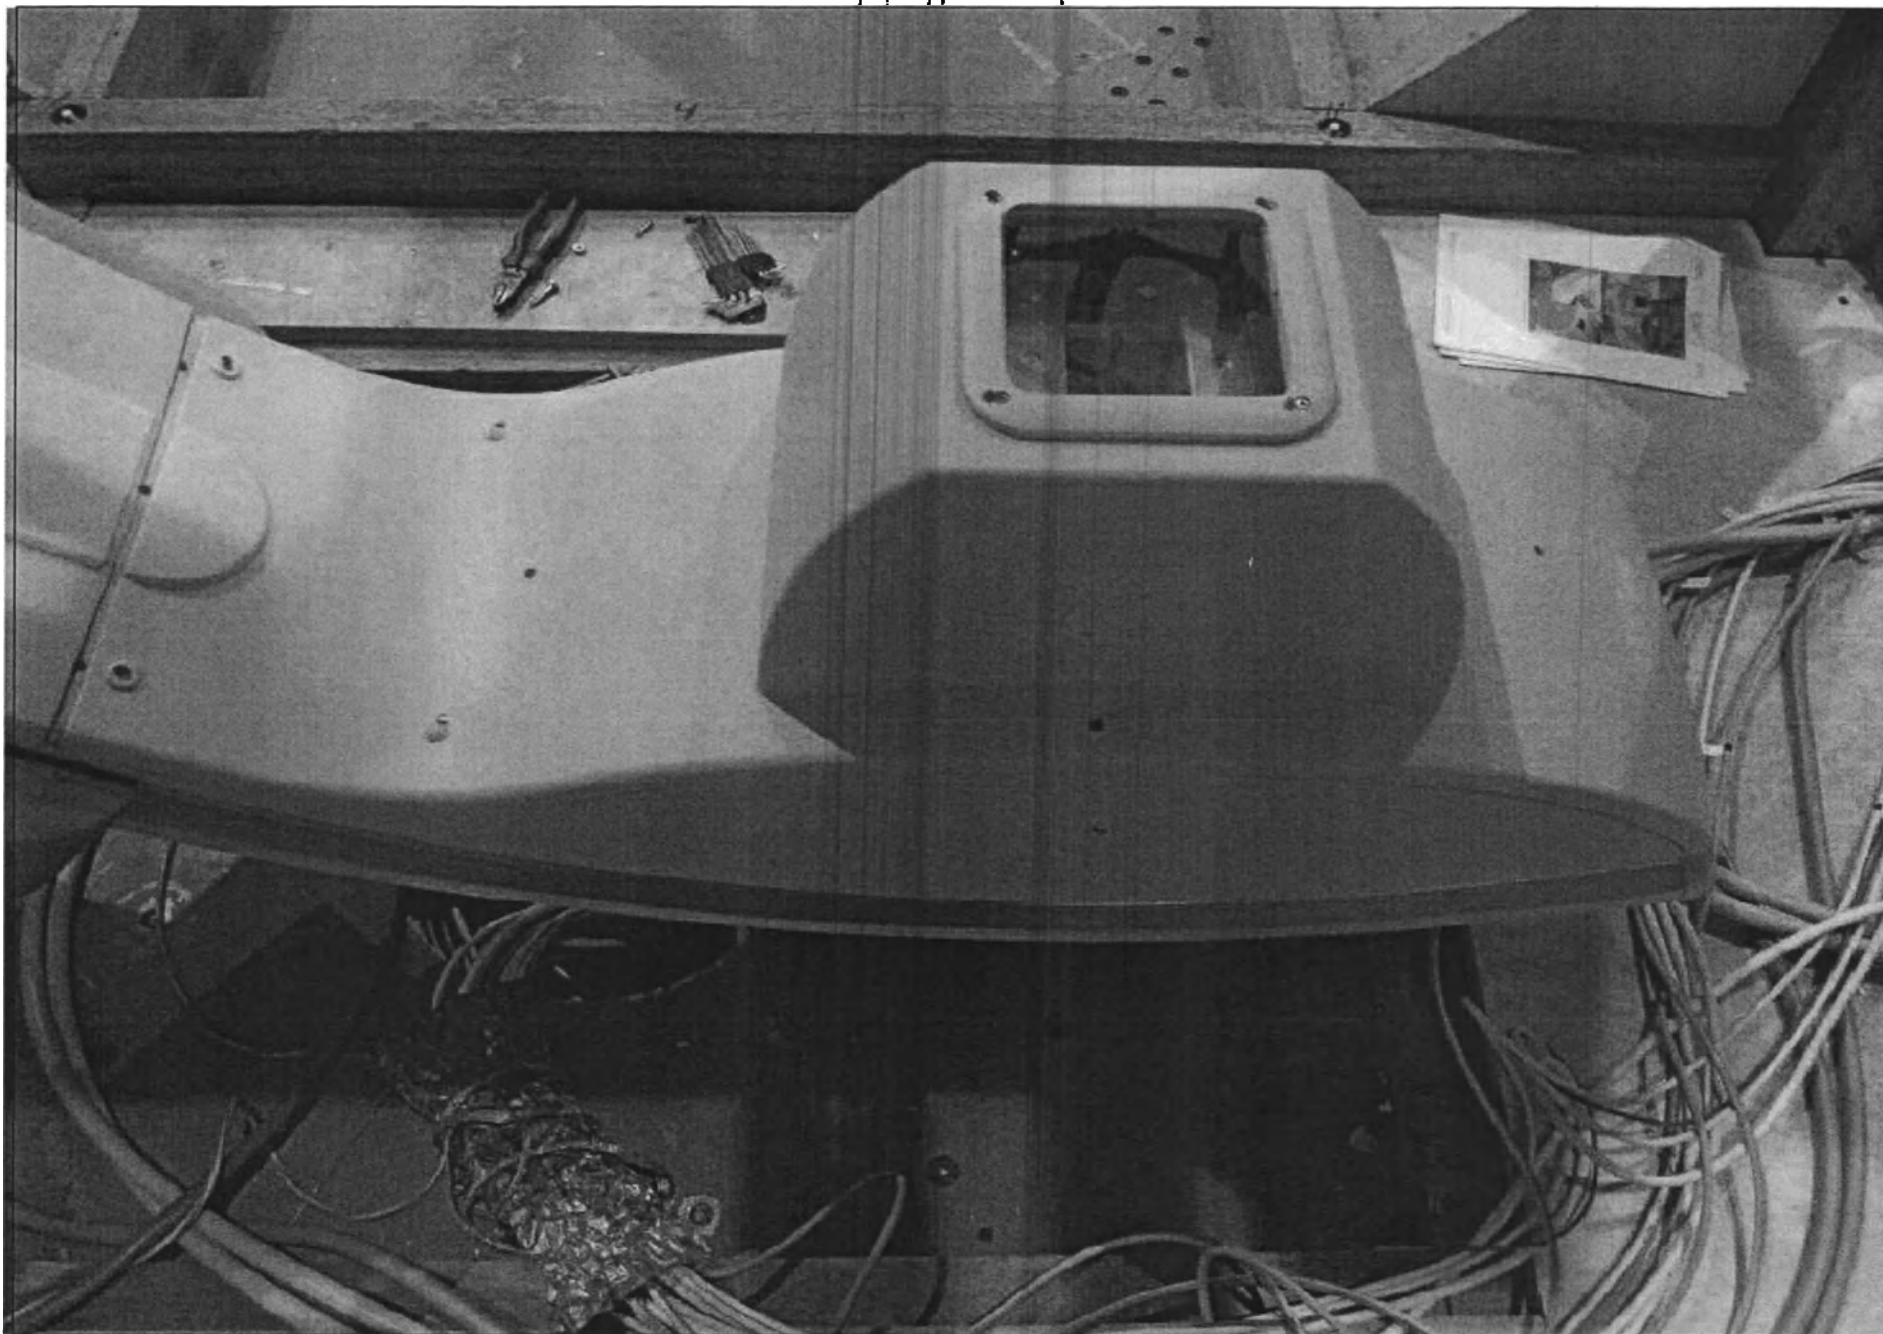


1.д. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

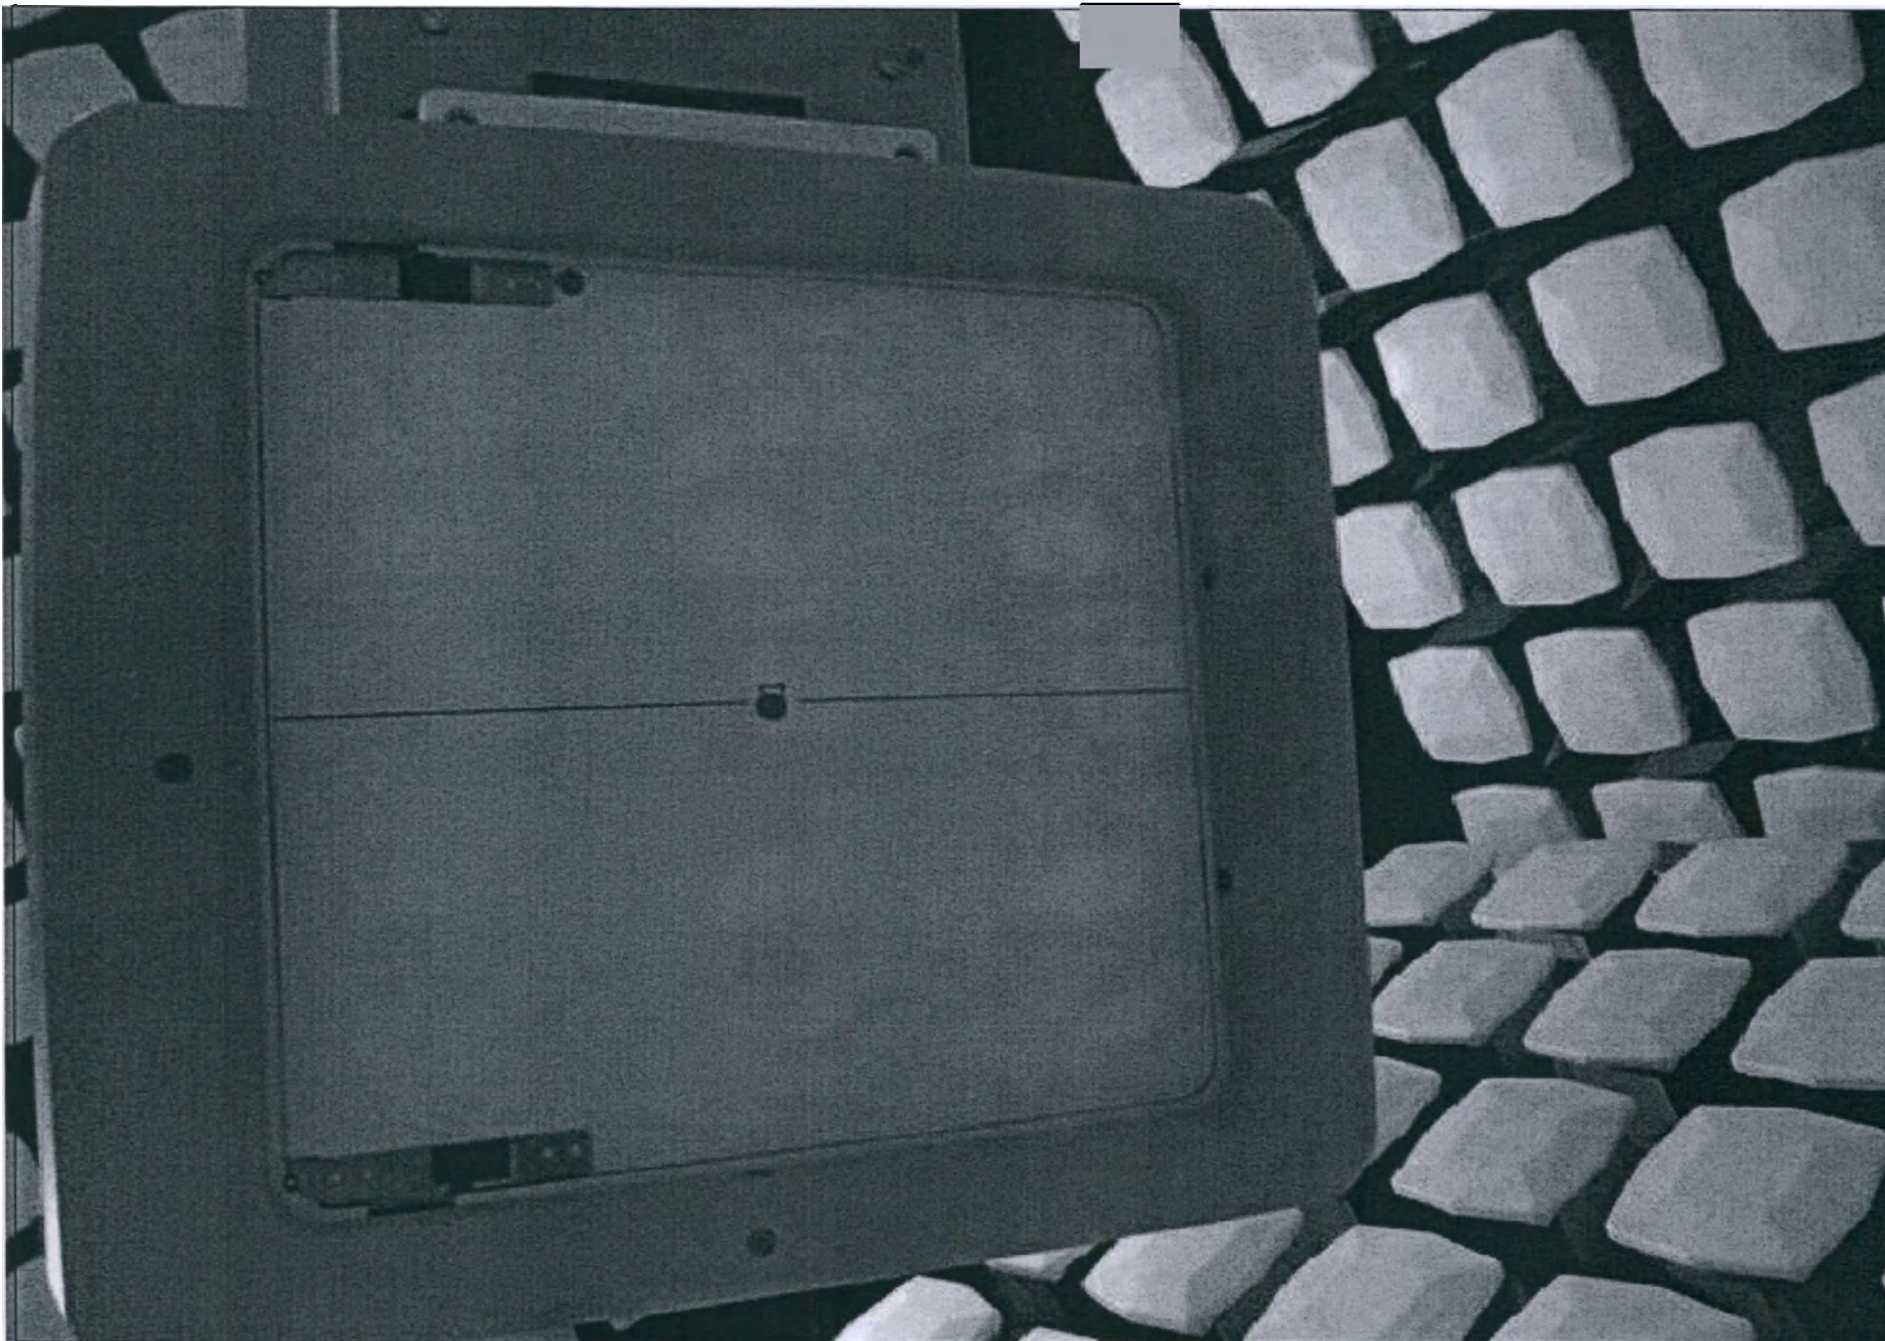


1.е. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

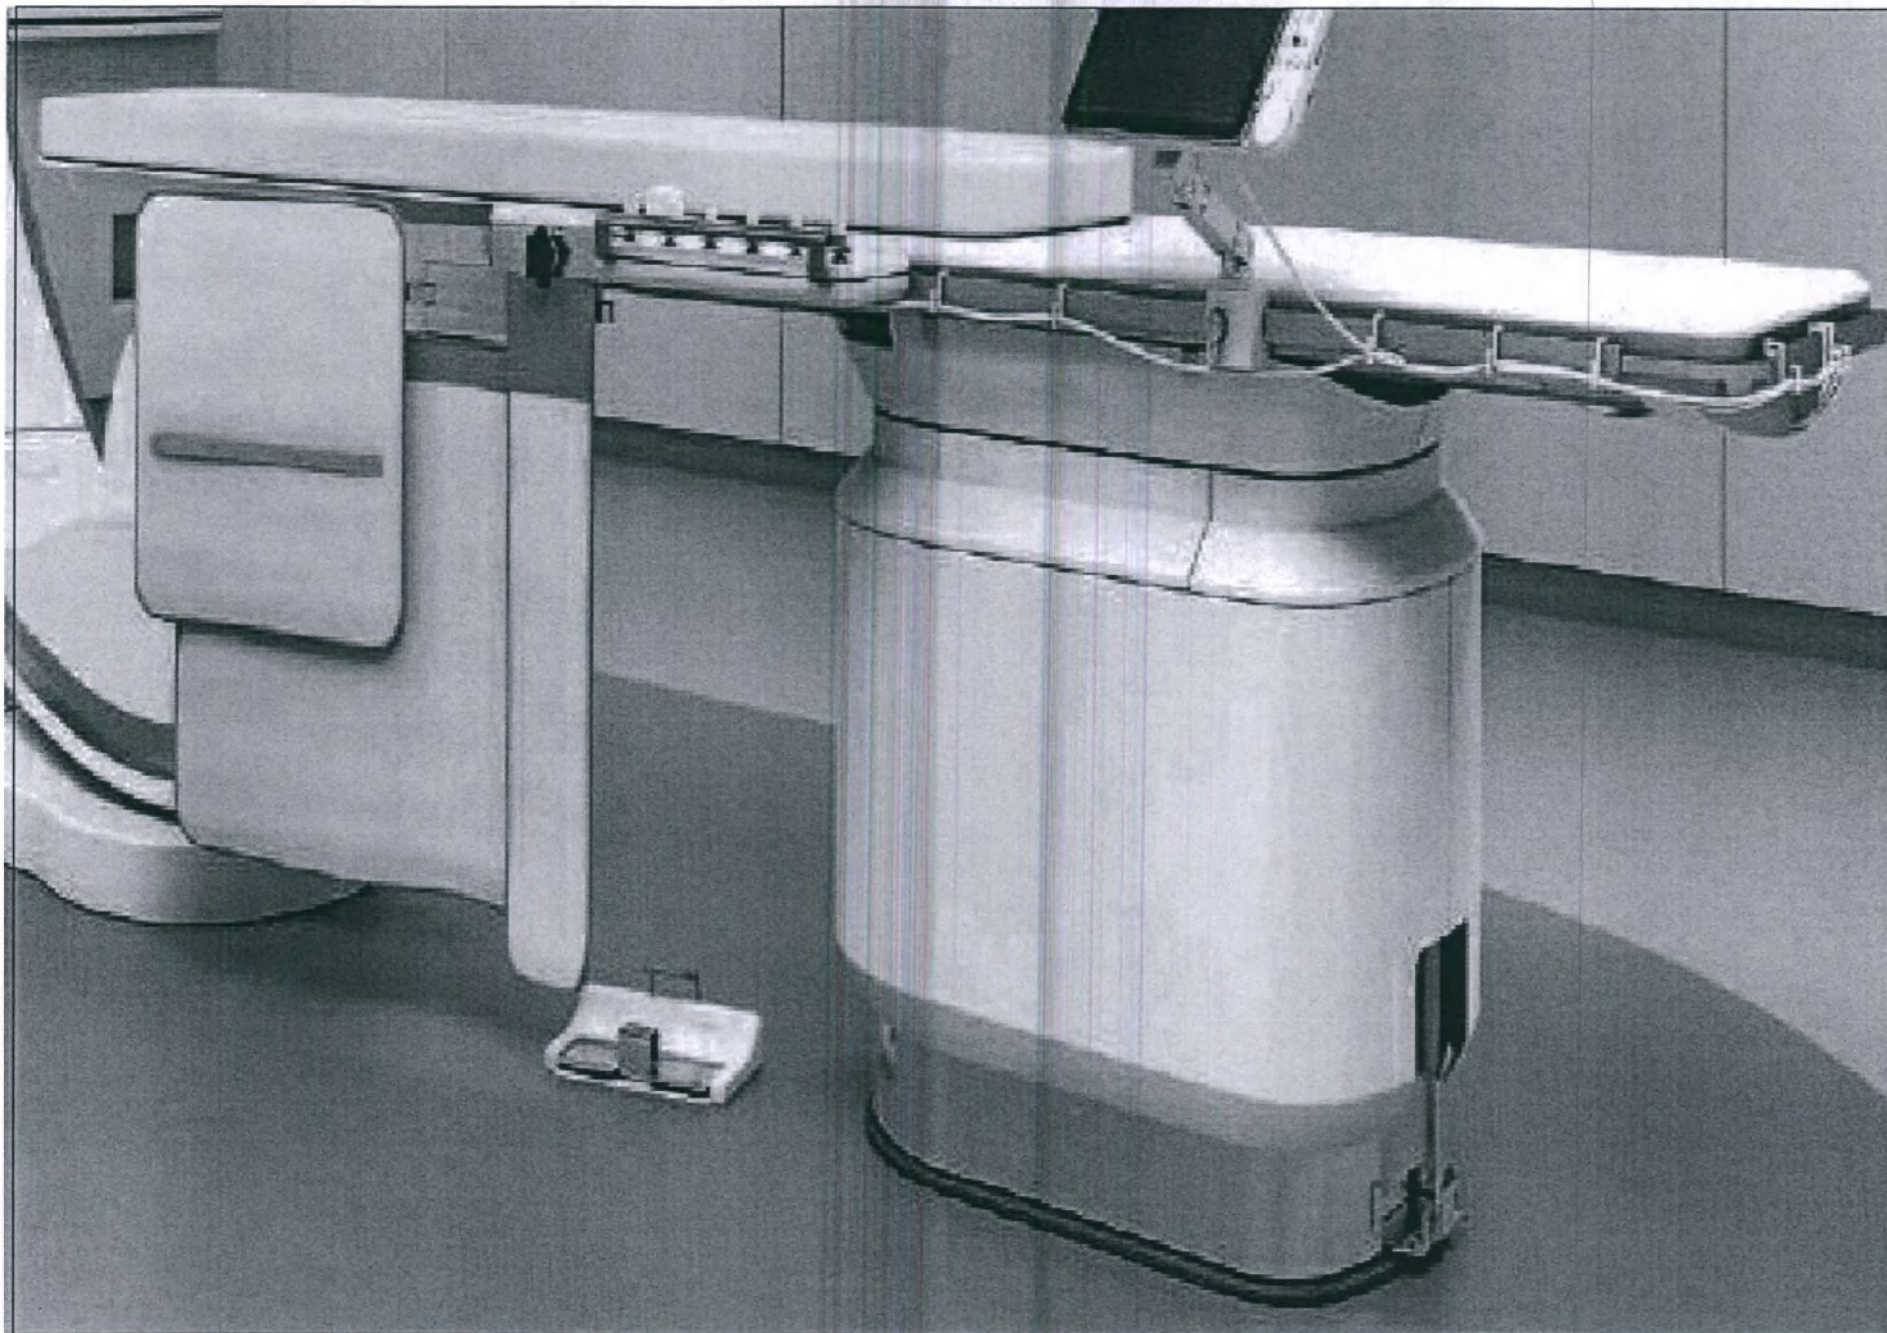


2.а. Стол пациента, варианты исполнения: *Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.*

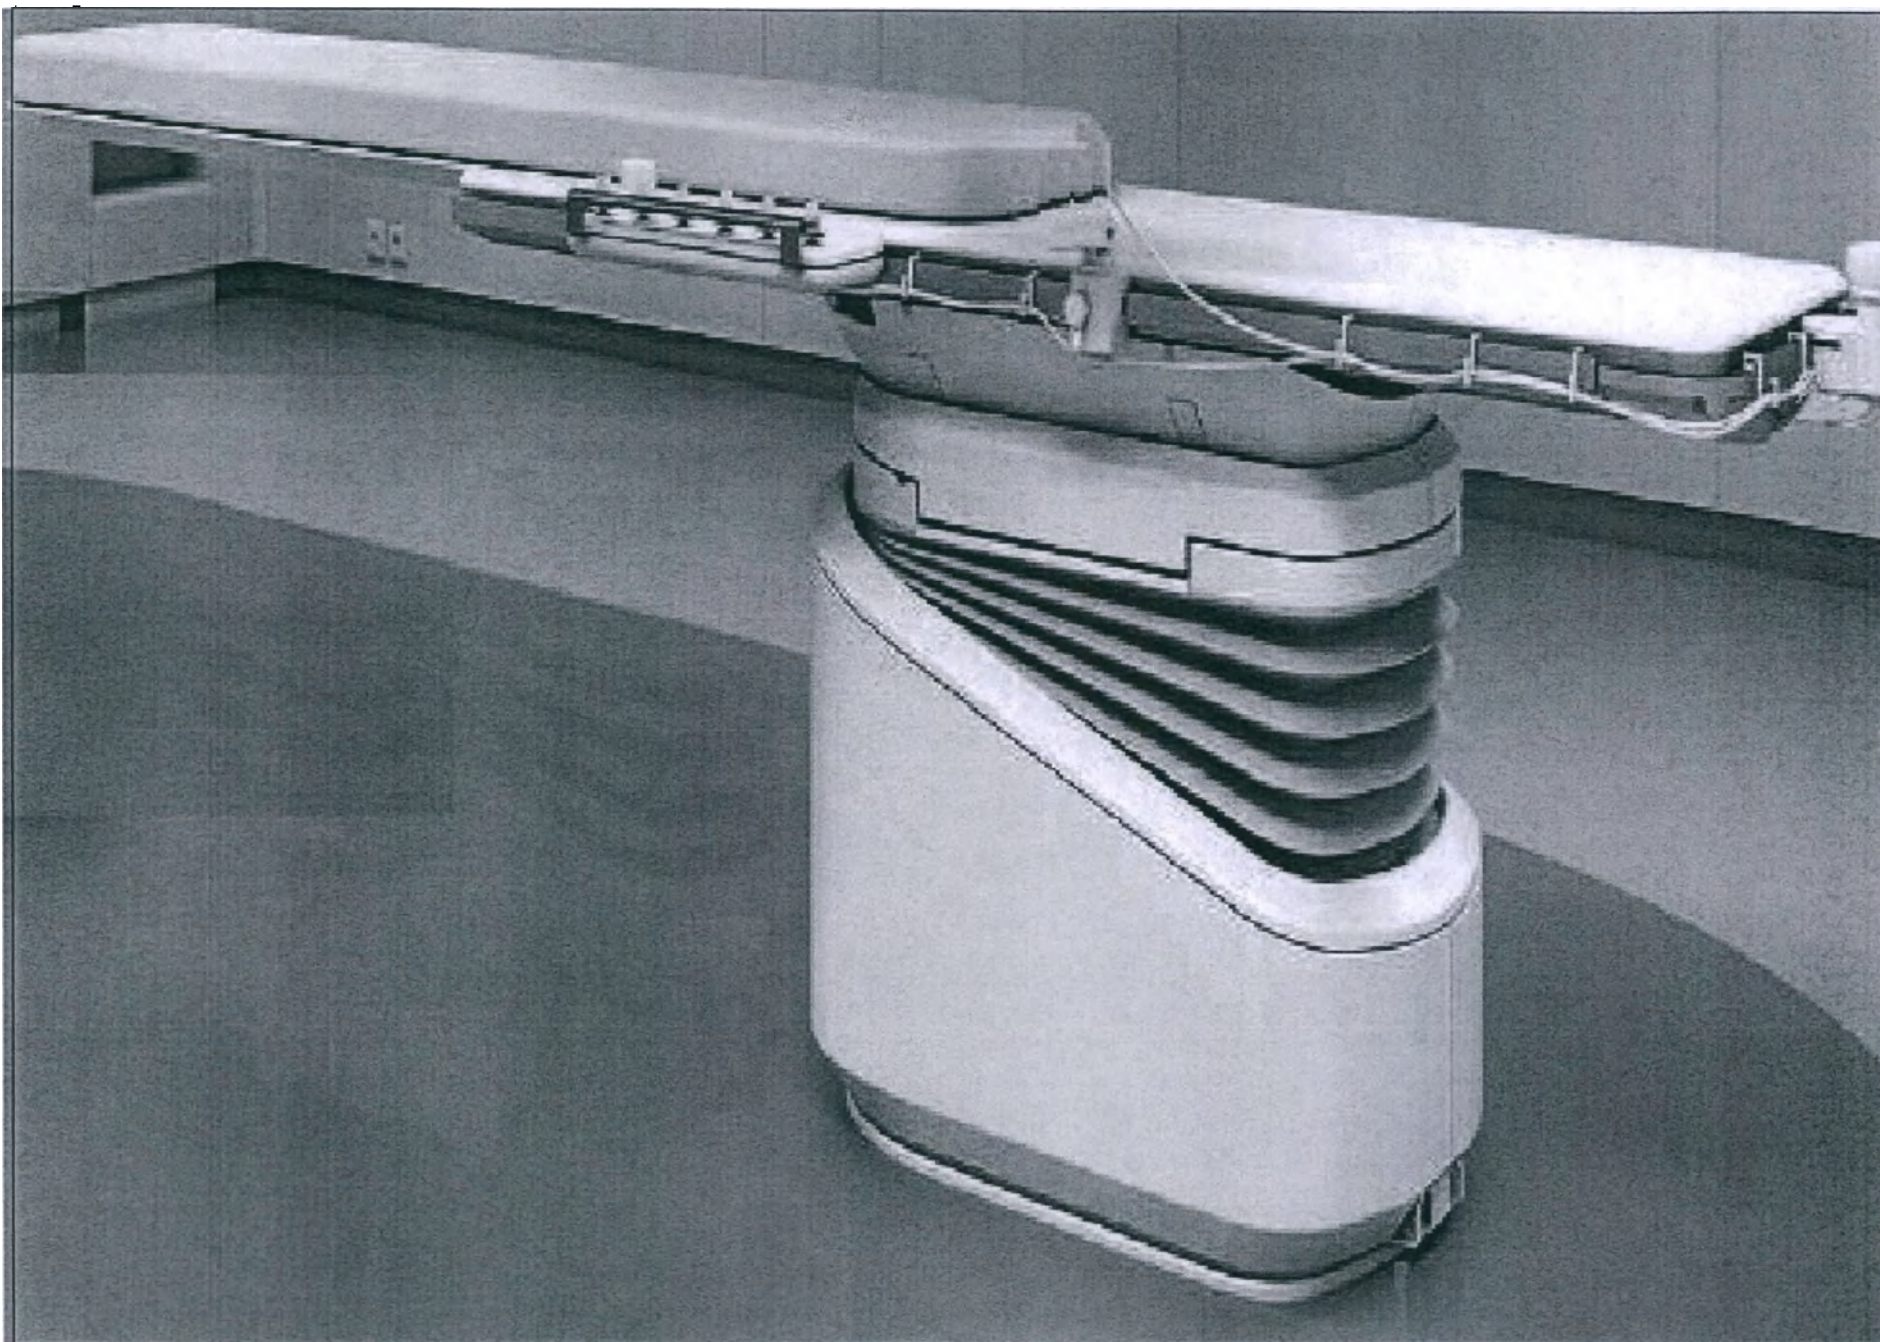


2.6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

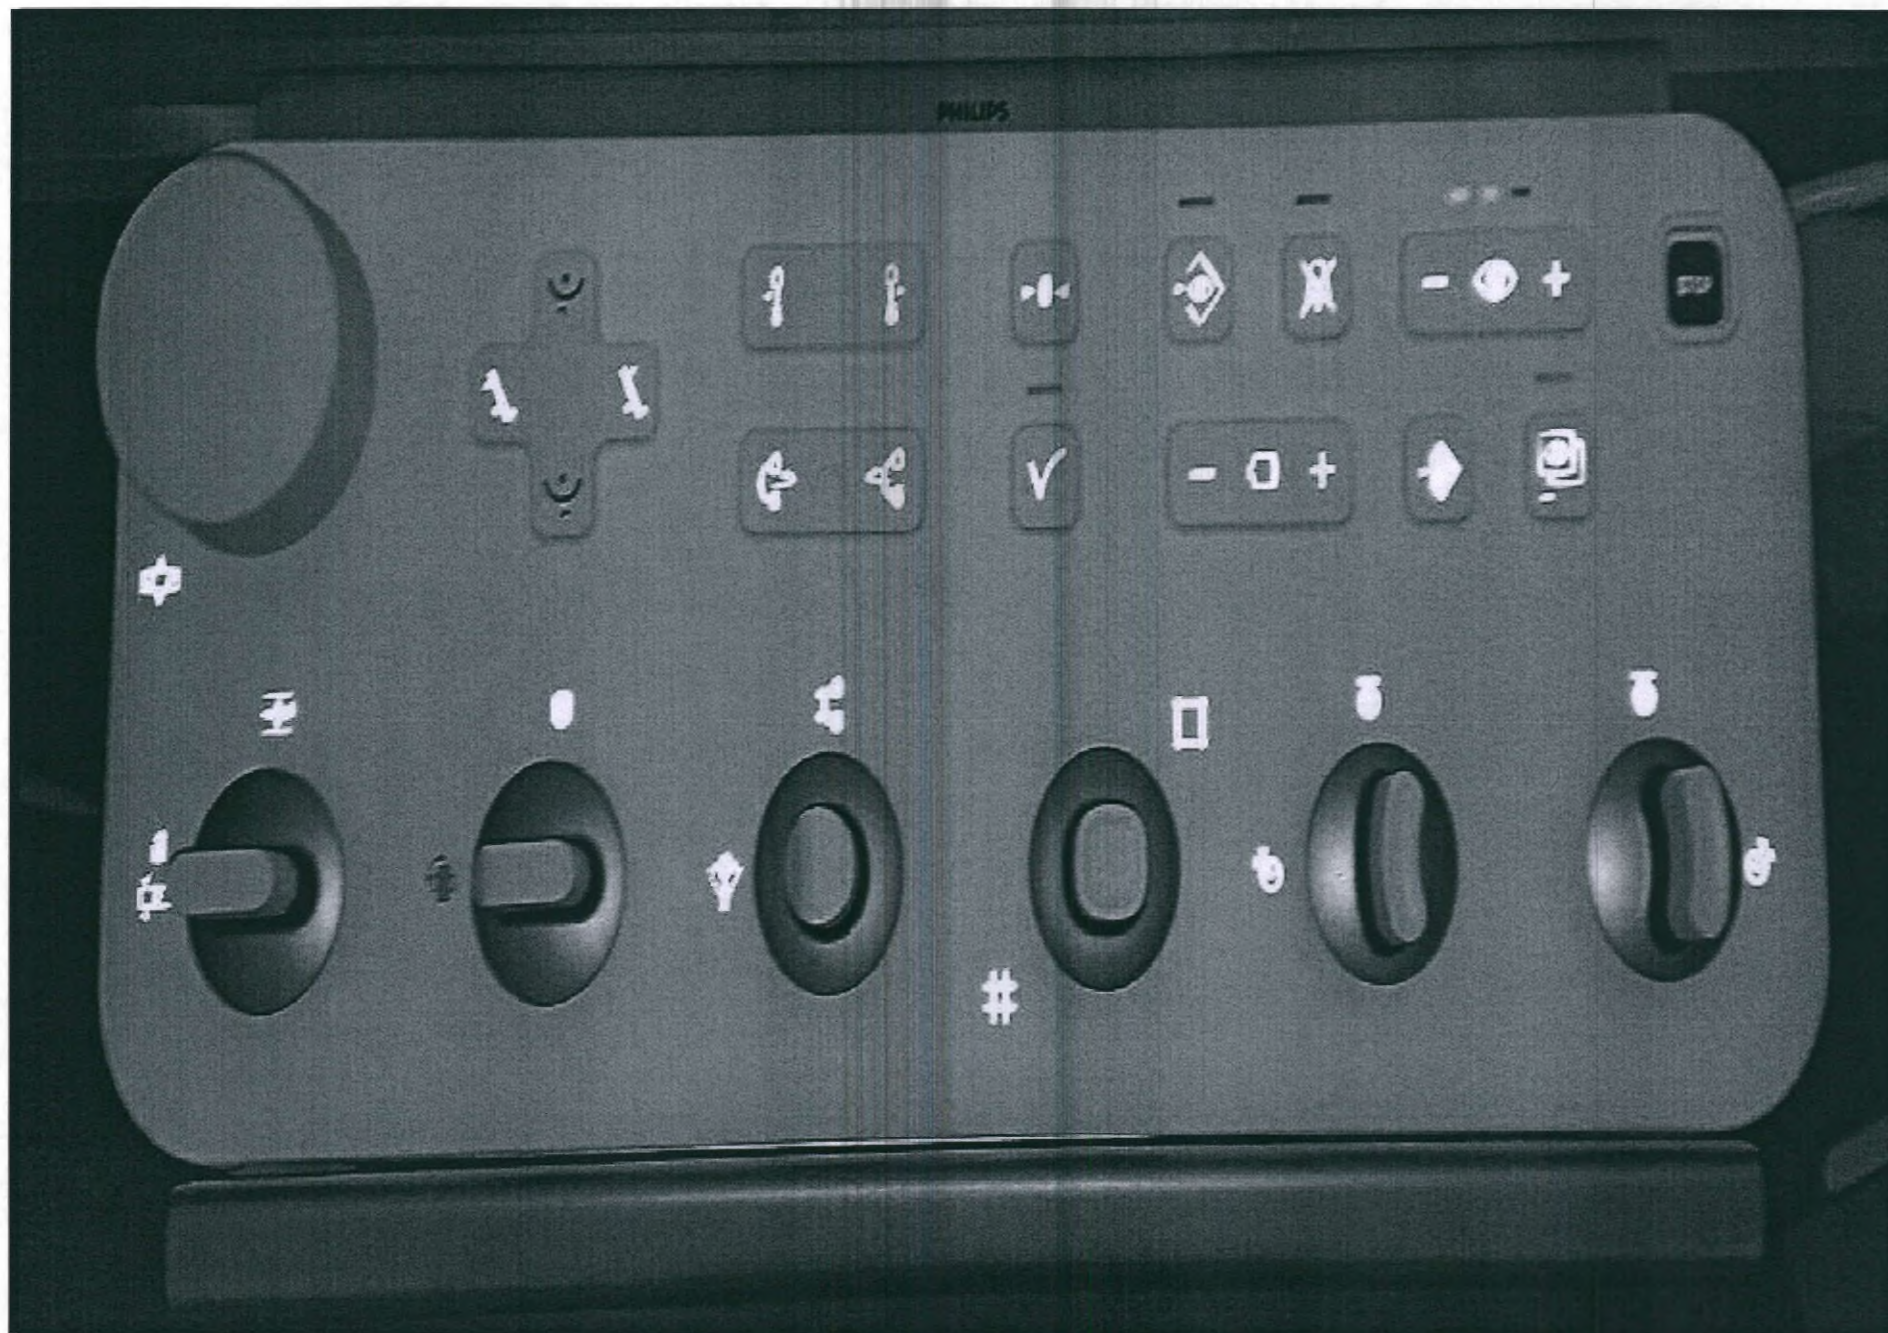


3. Модуль управления, не более 4 шт.

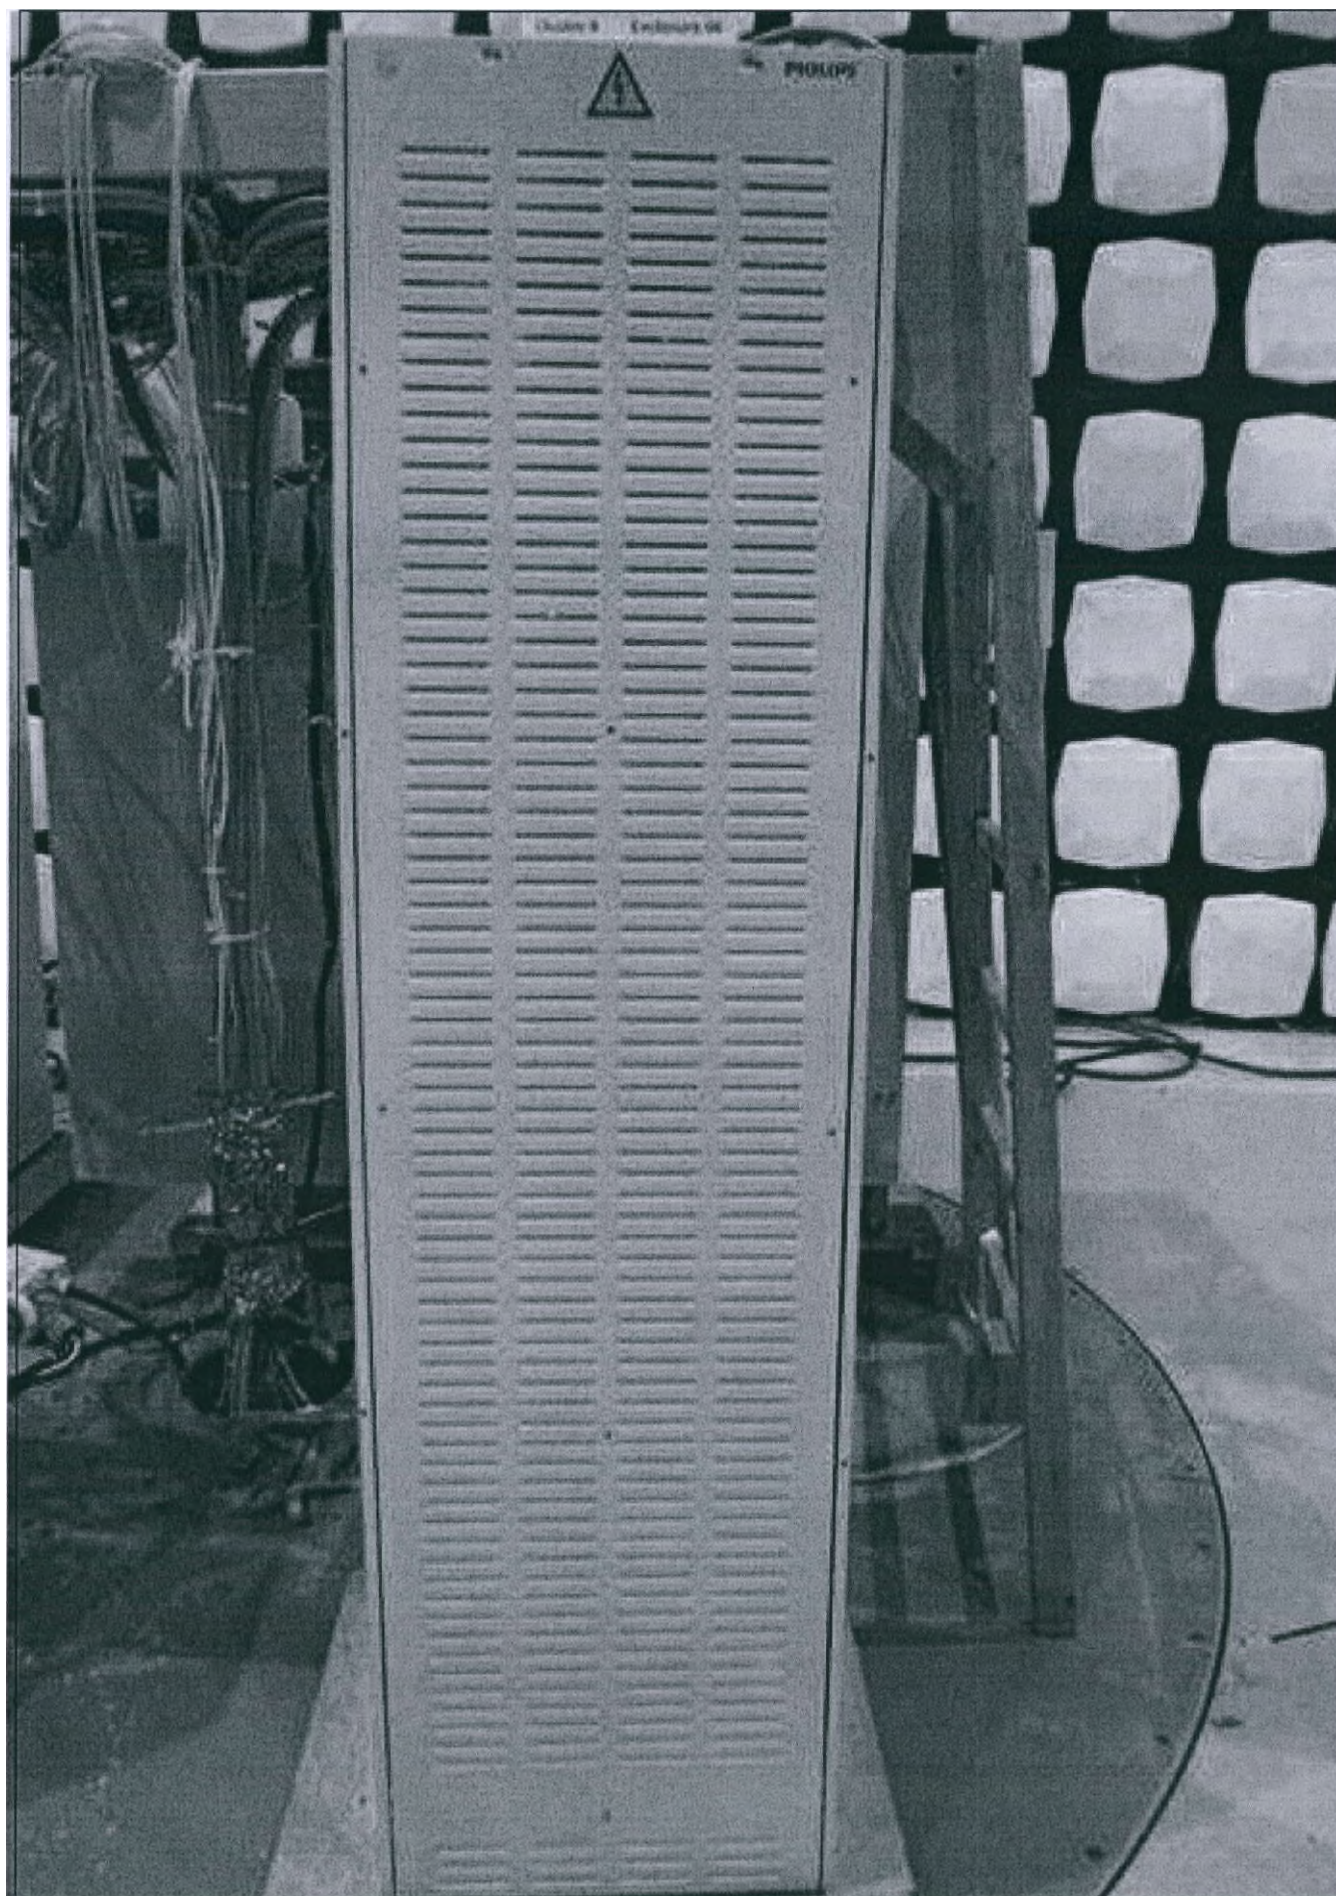


4.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

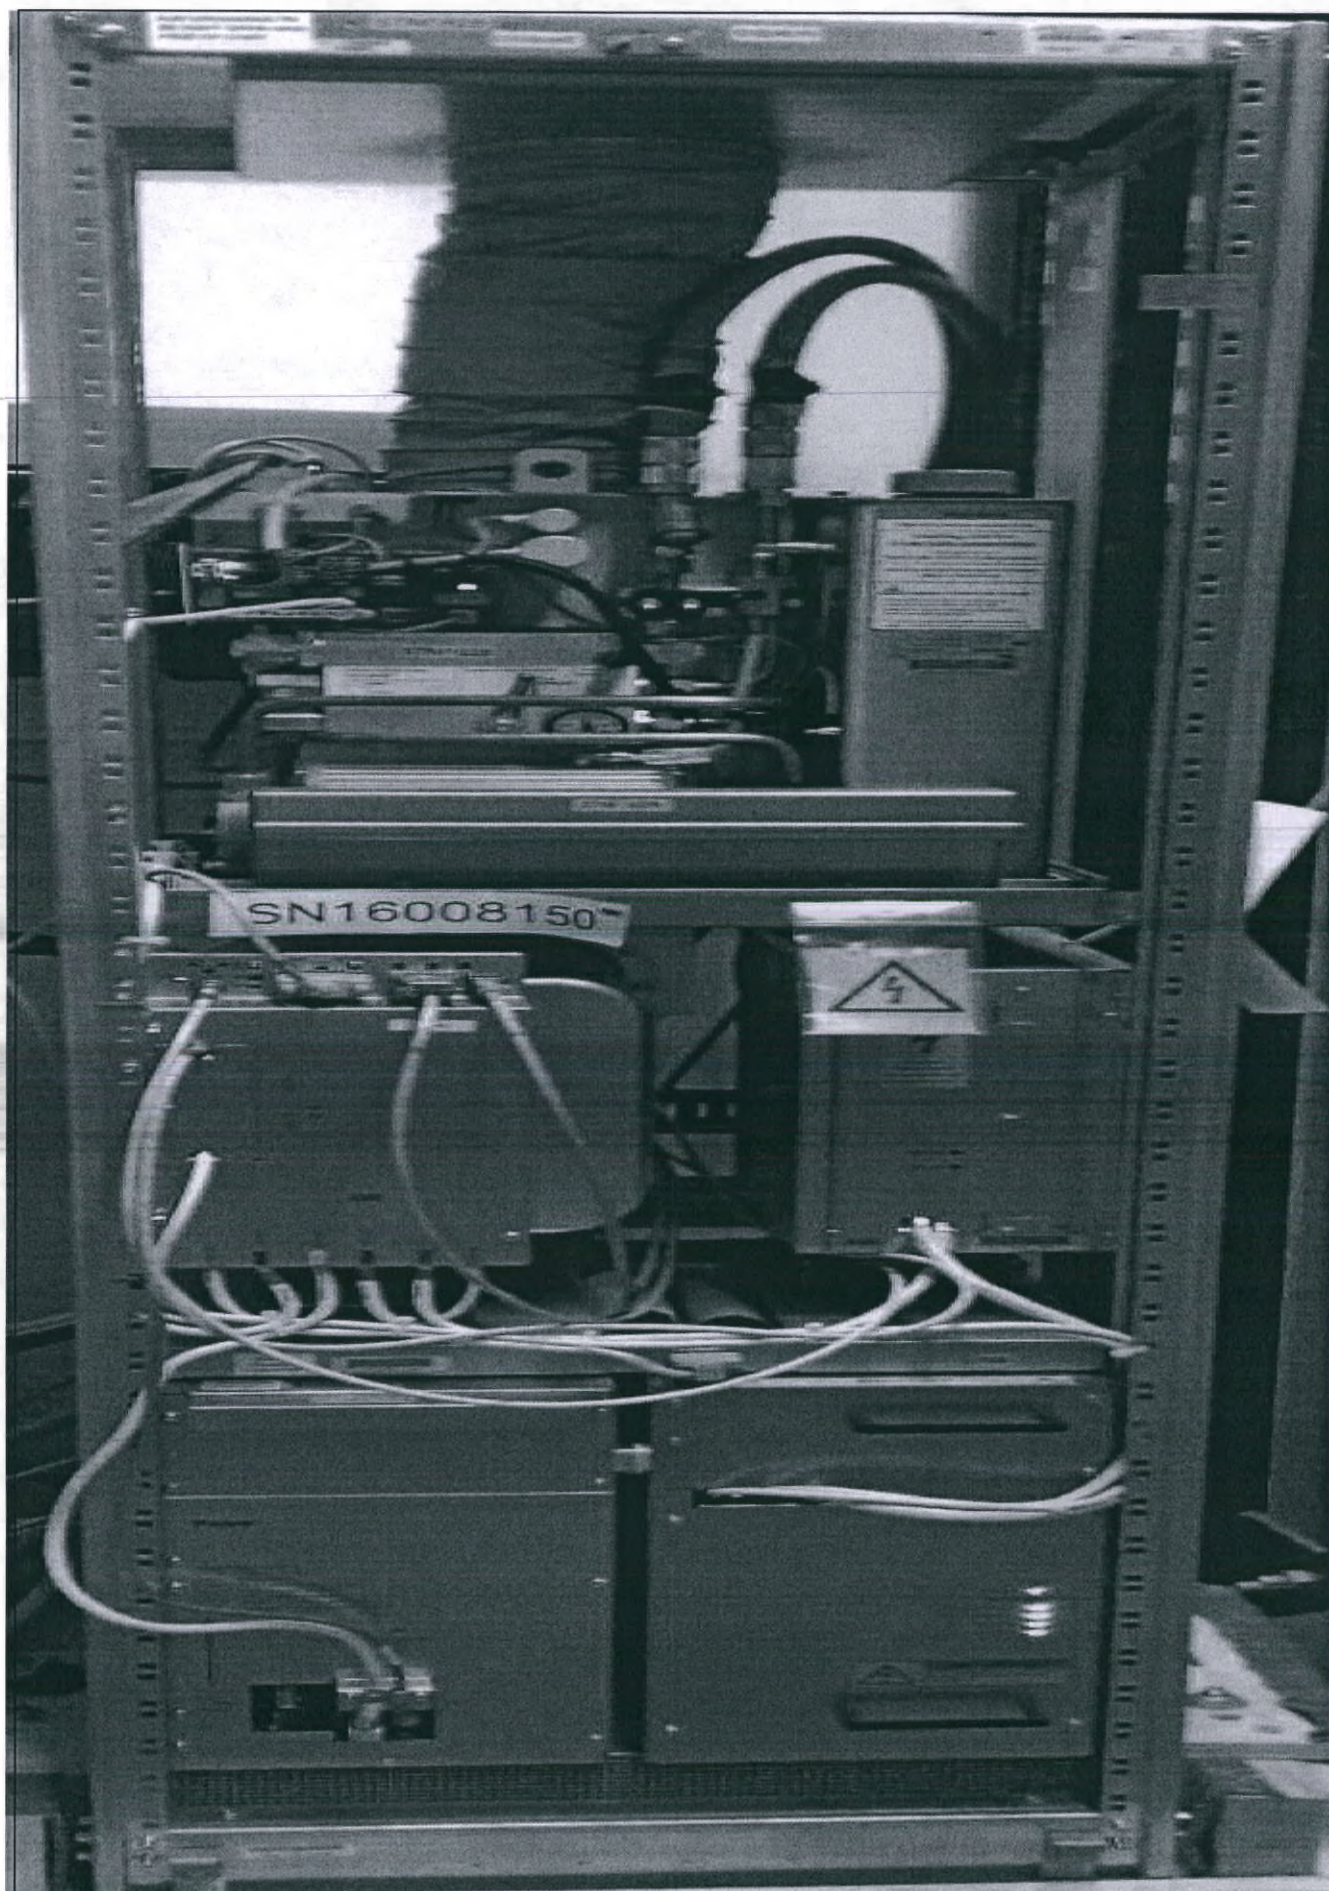


4.б. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

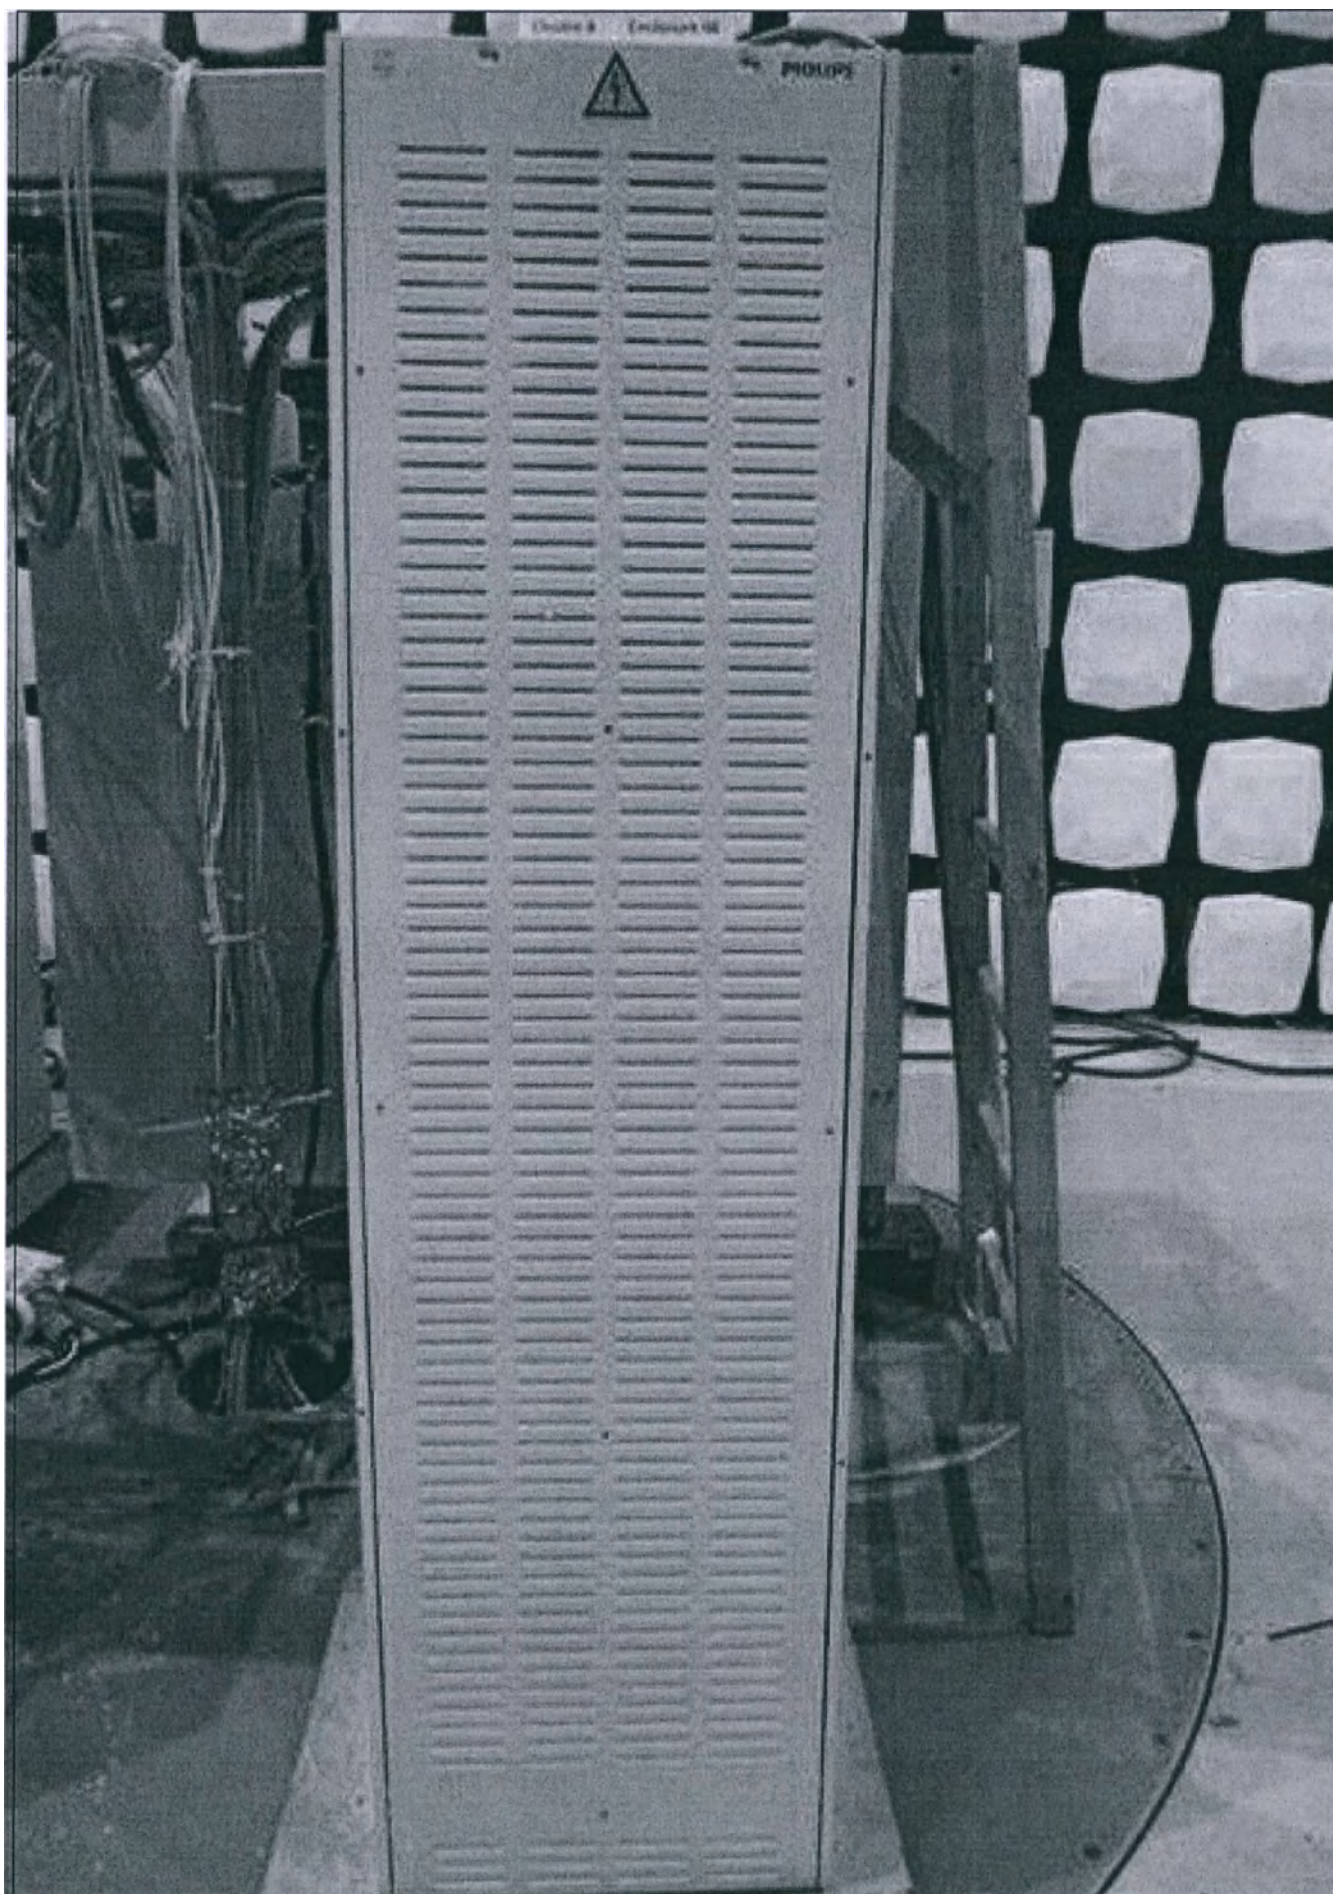


5.а. Шкаф управления.

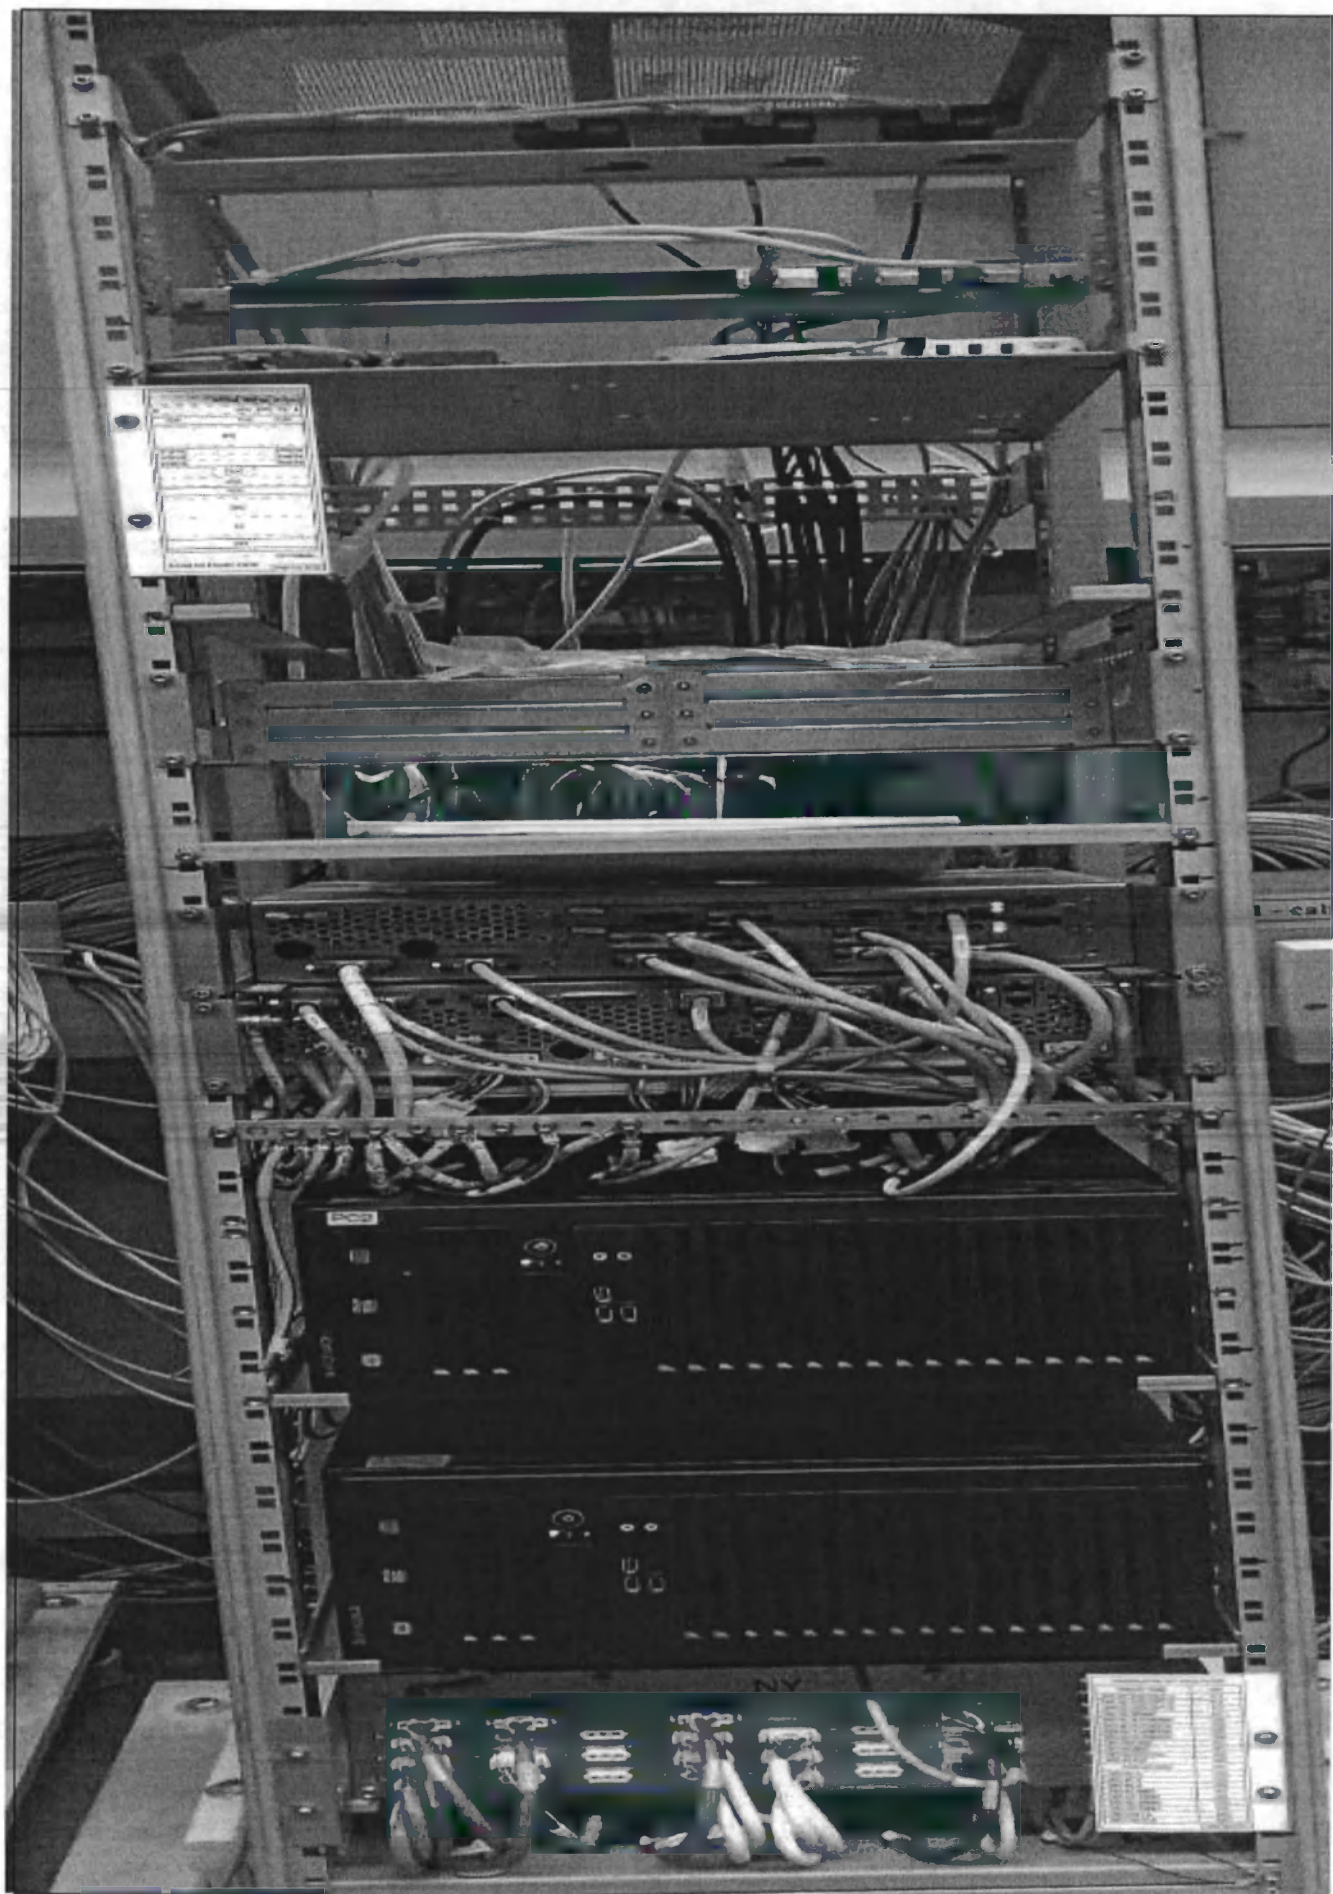


5.6. Шкаф управления.

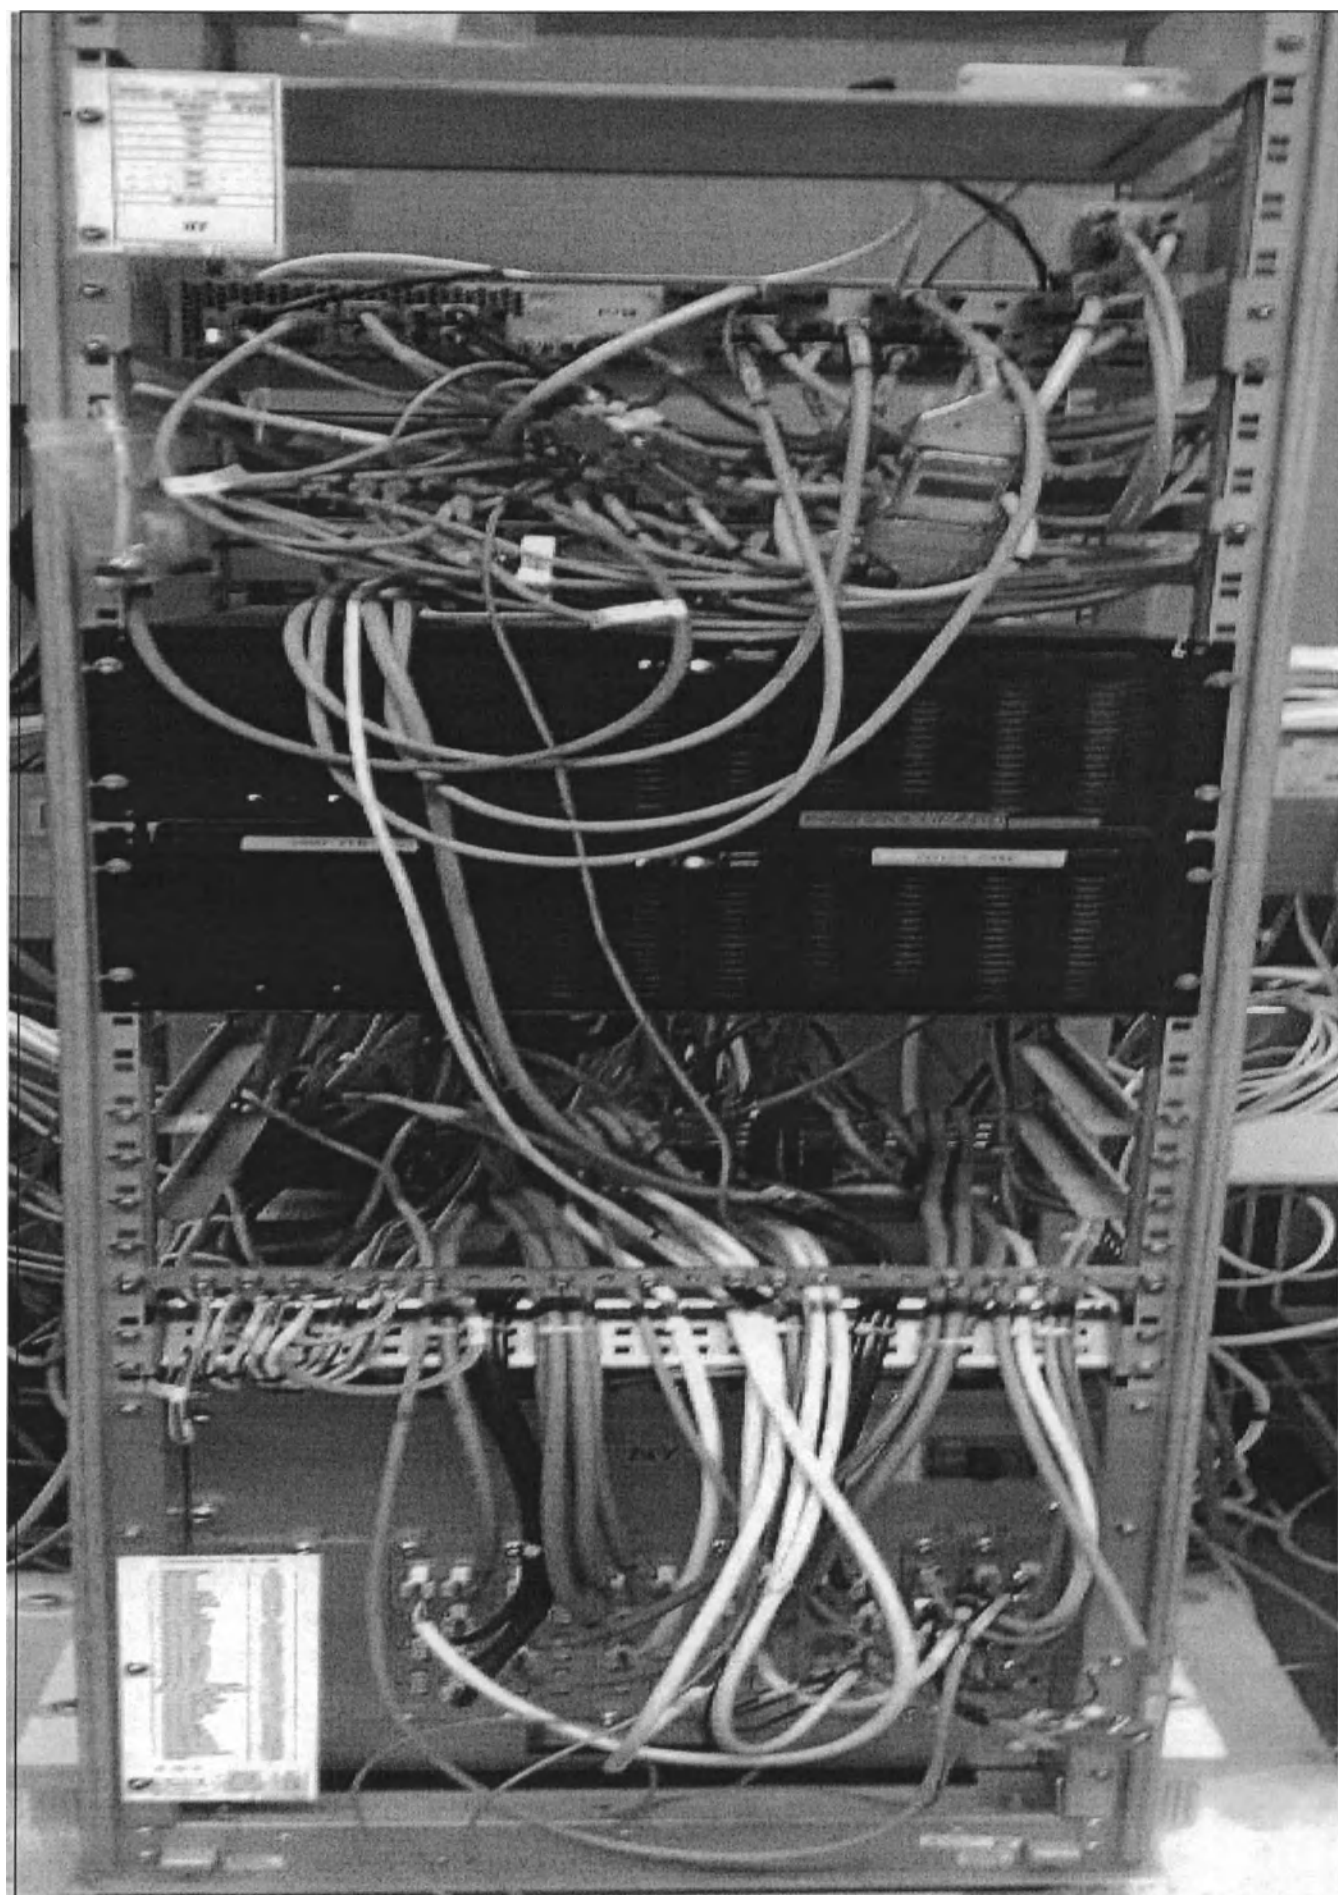


б.а. Распределительный щит.

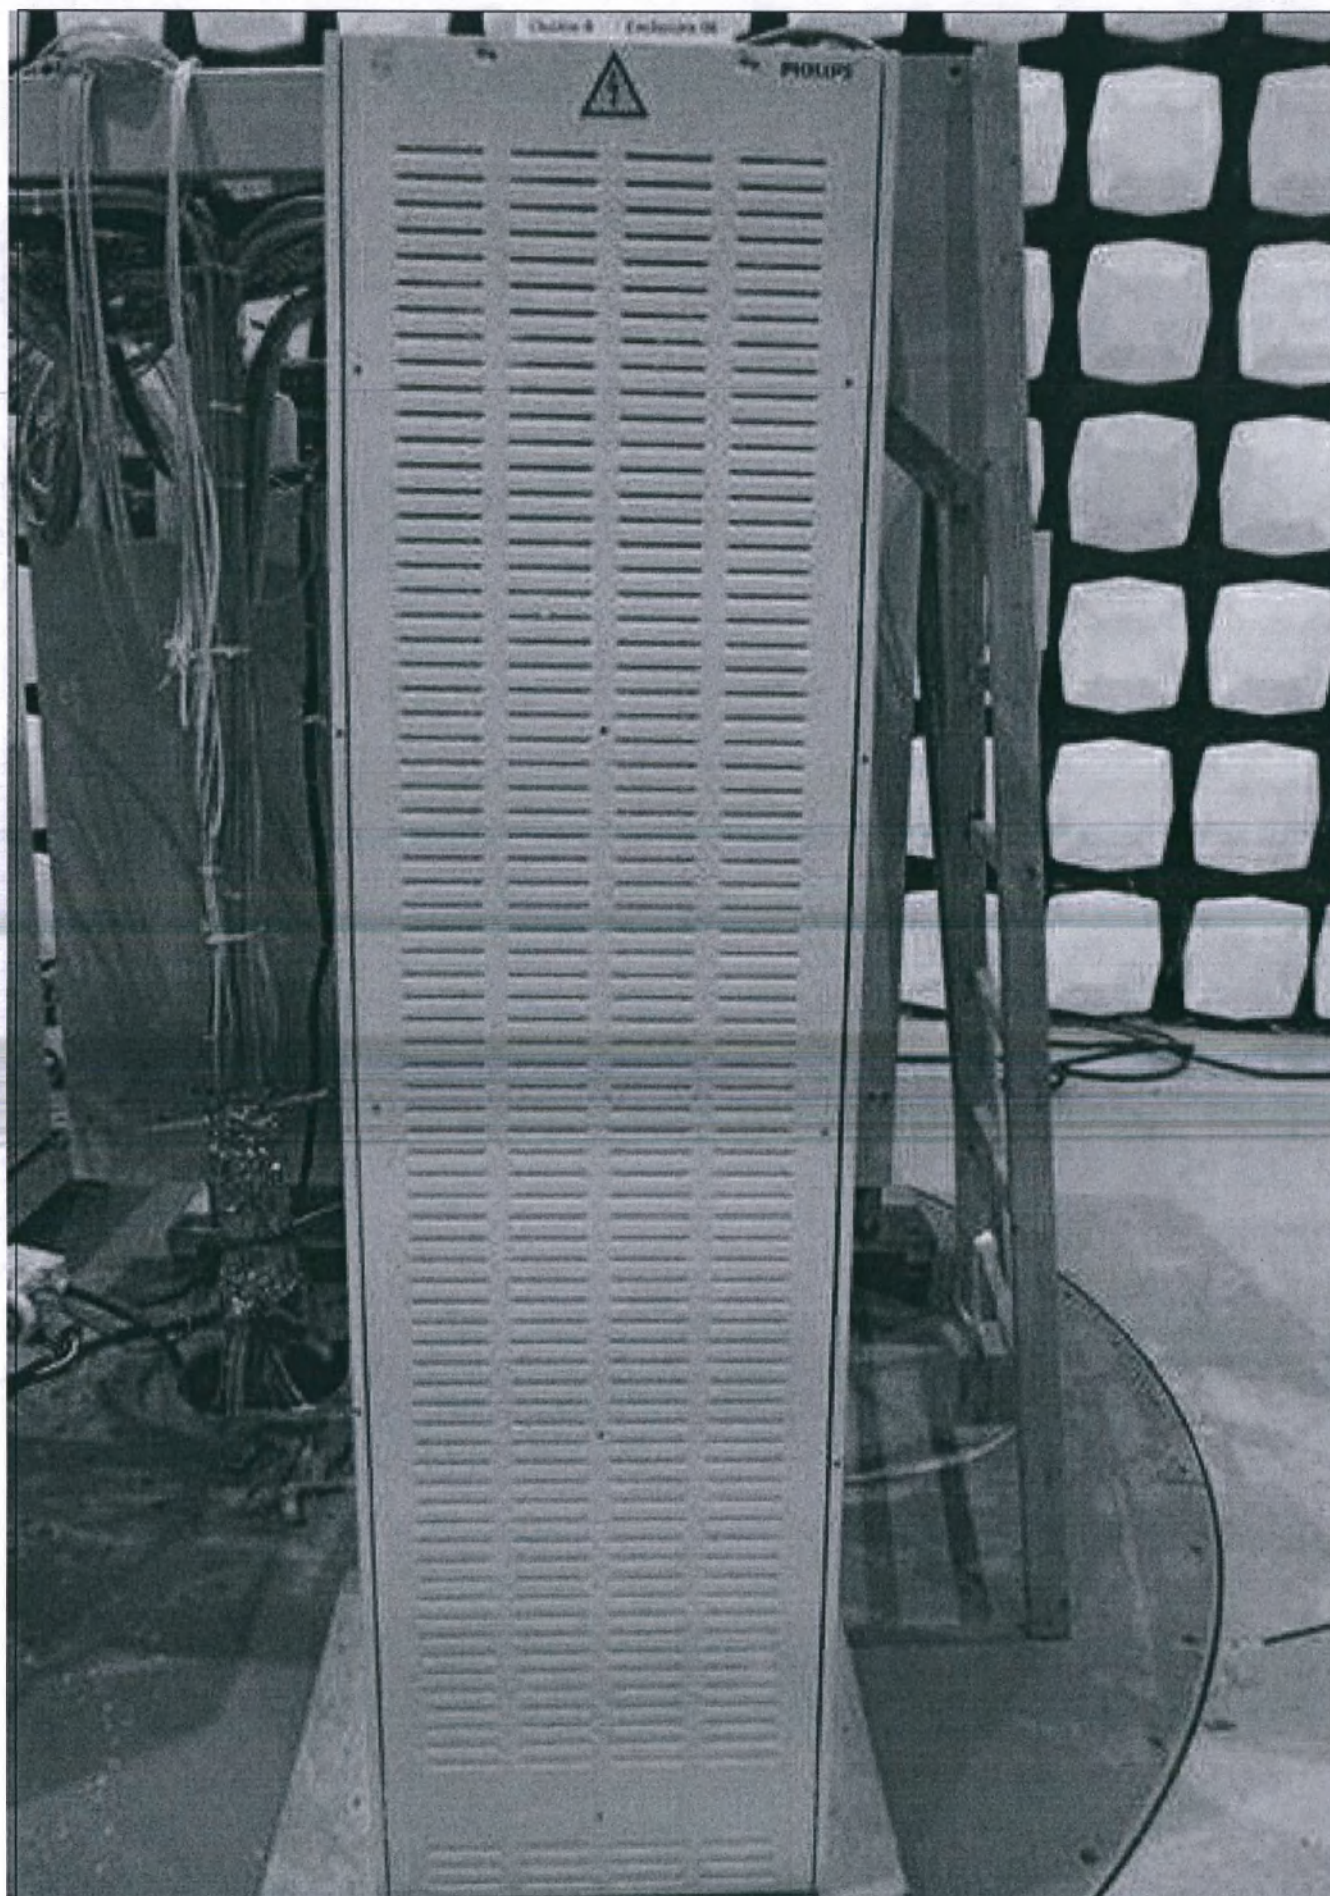


6.6. Распределительный щит.

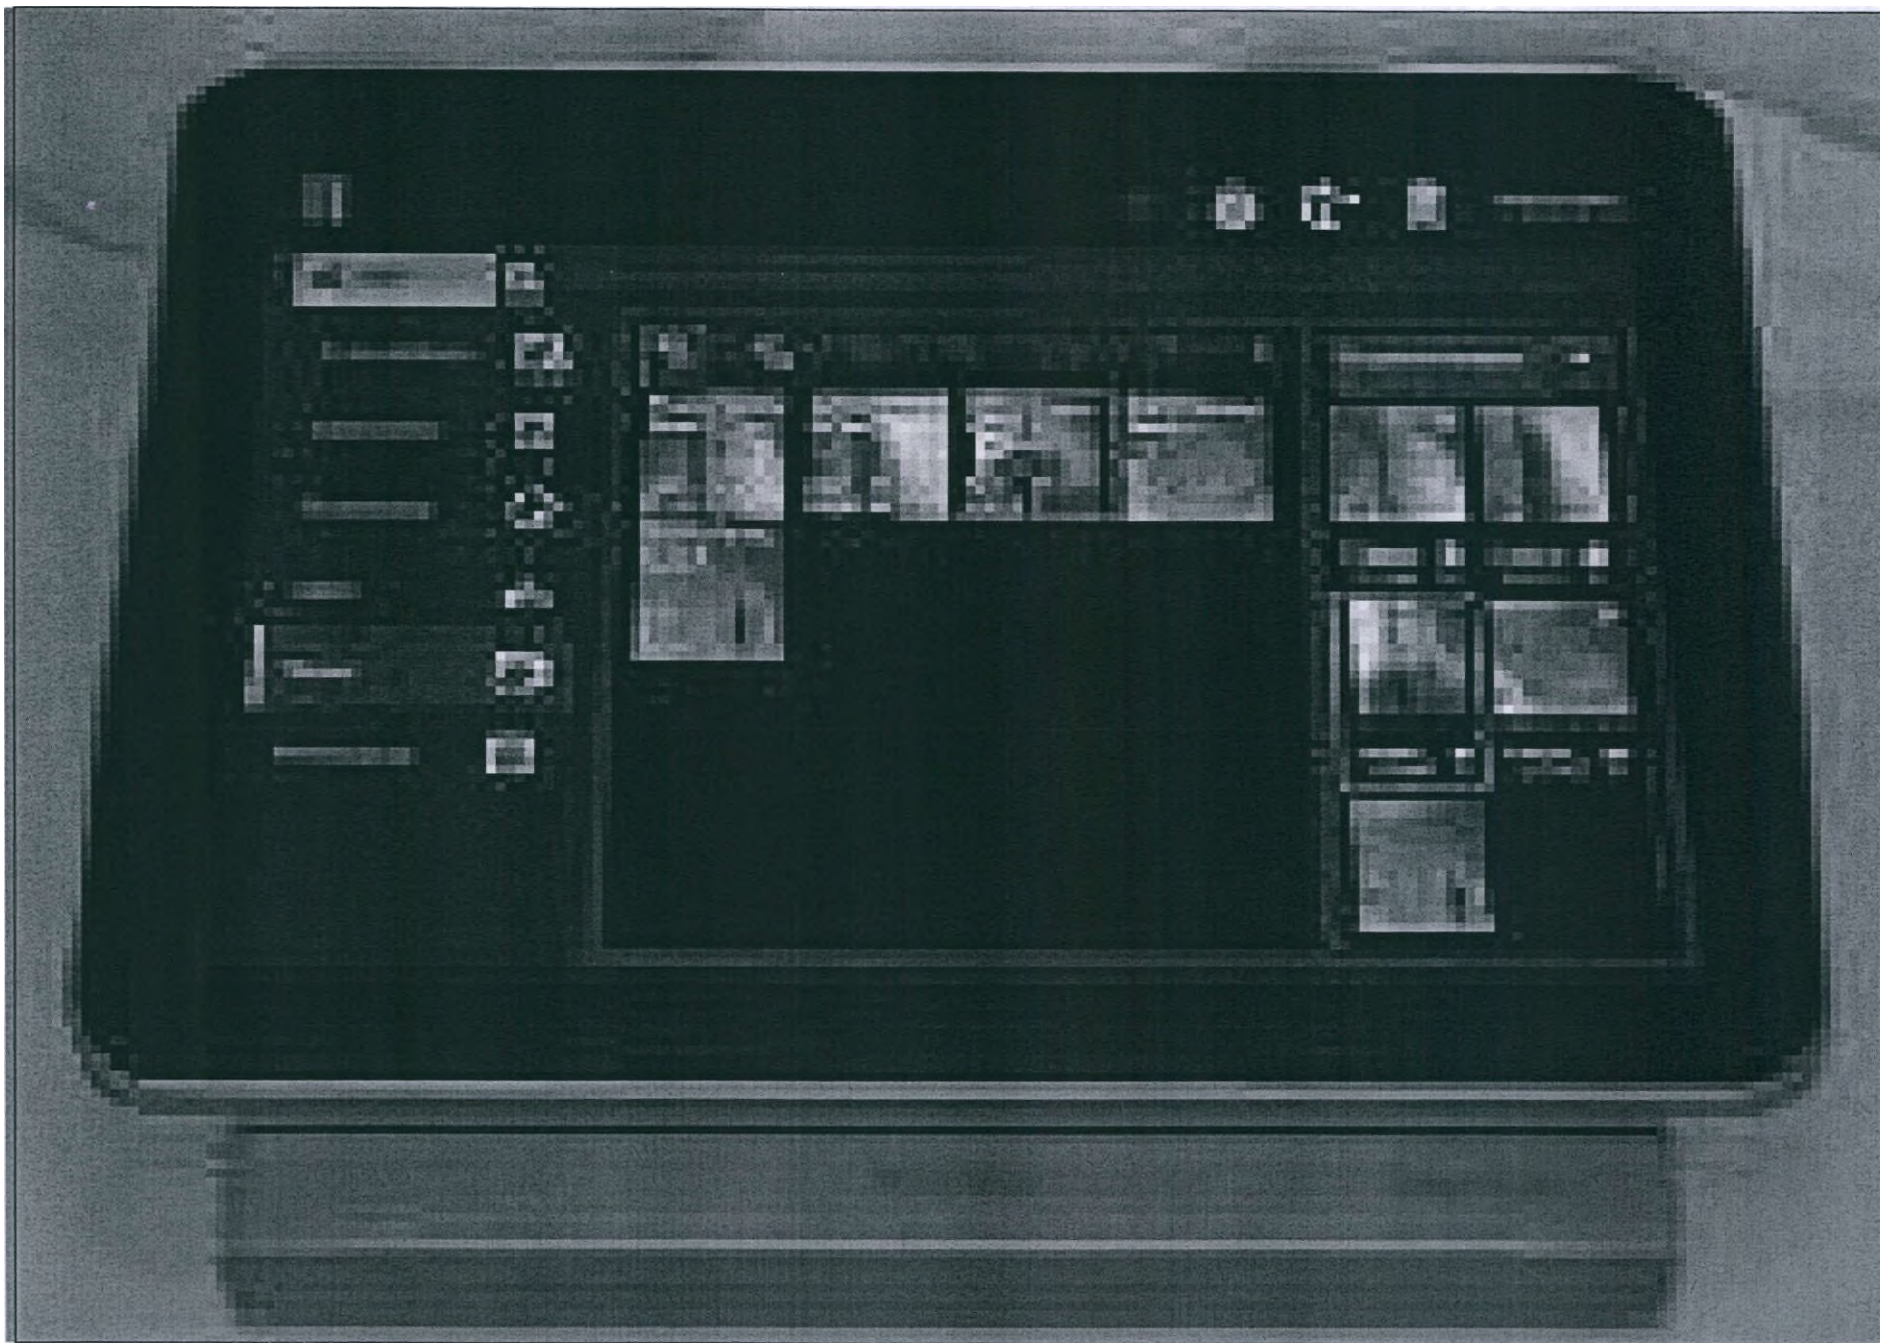

7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

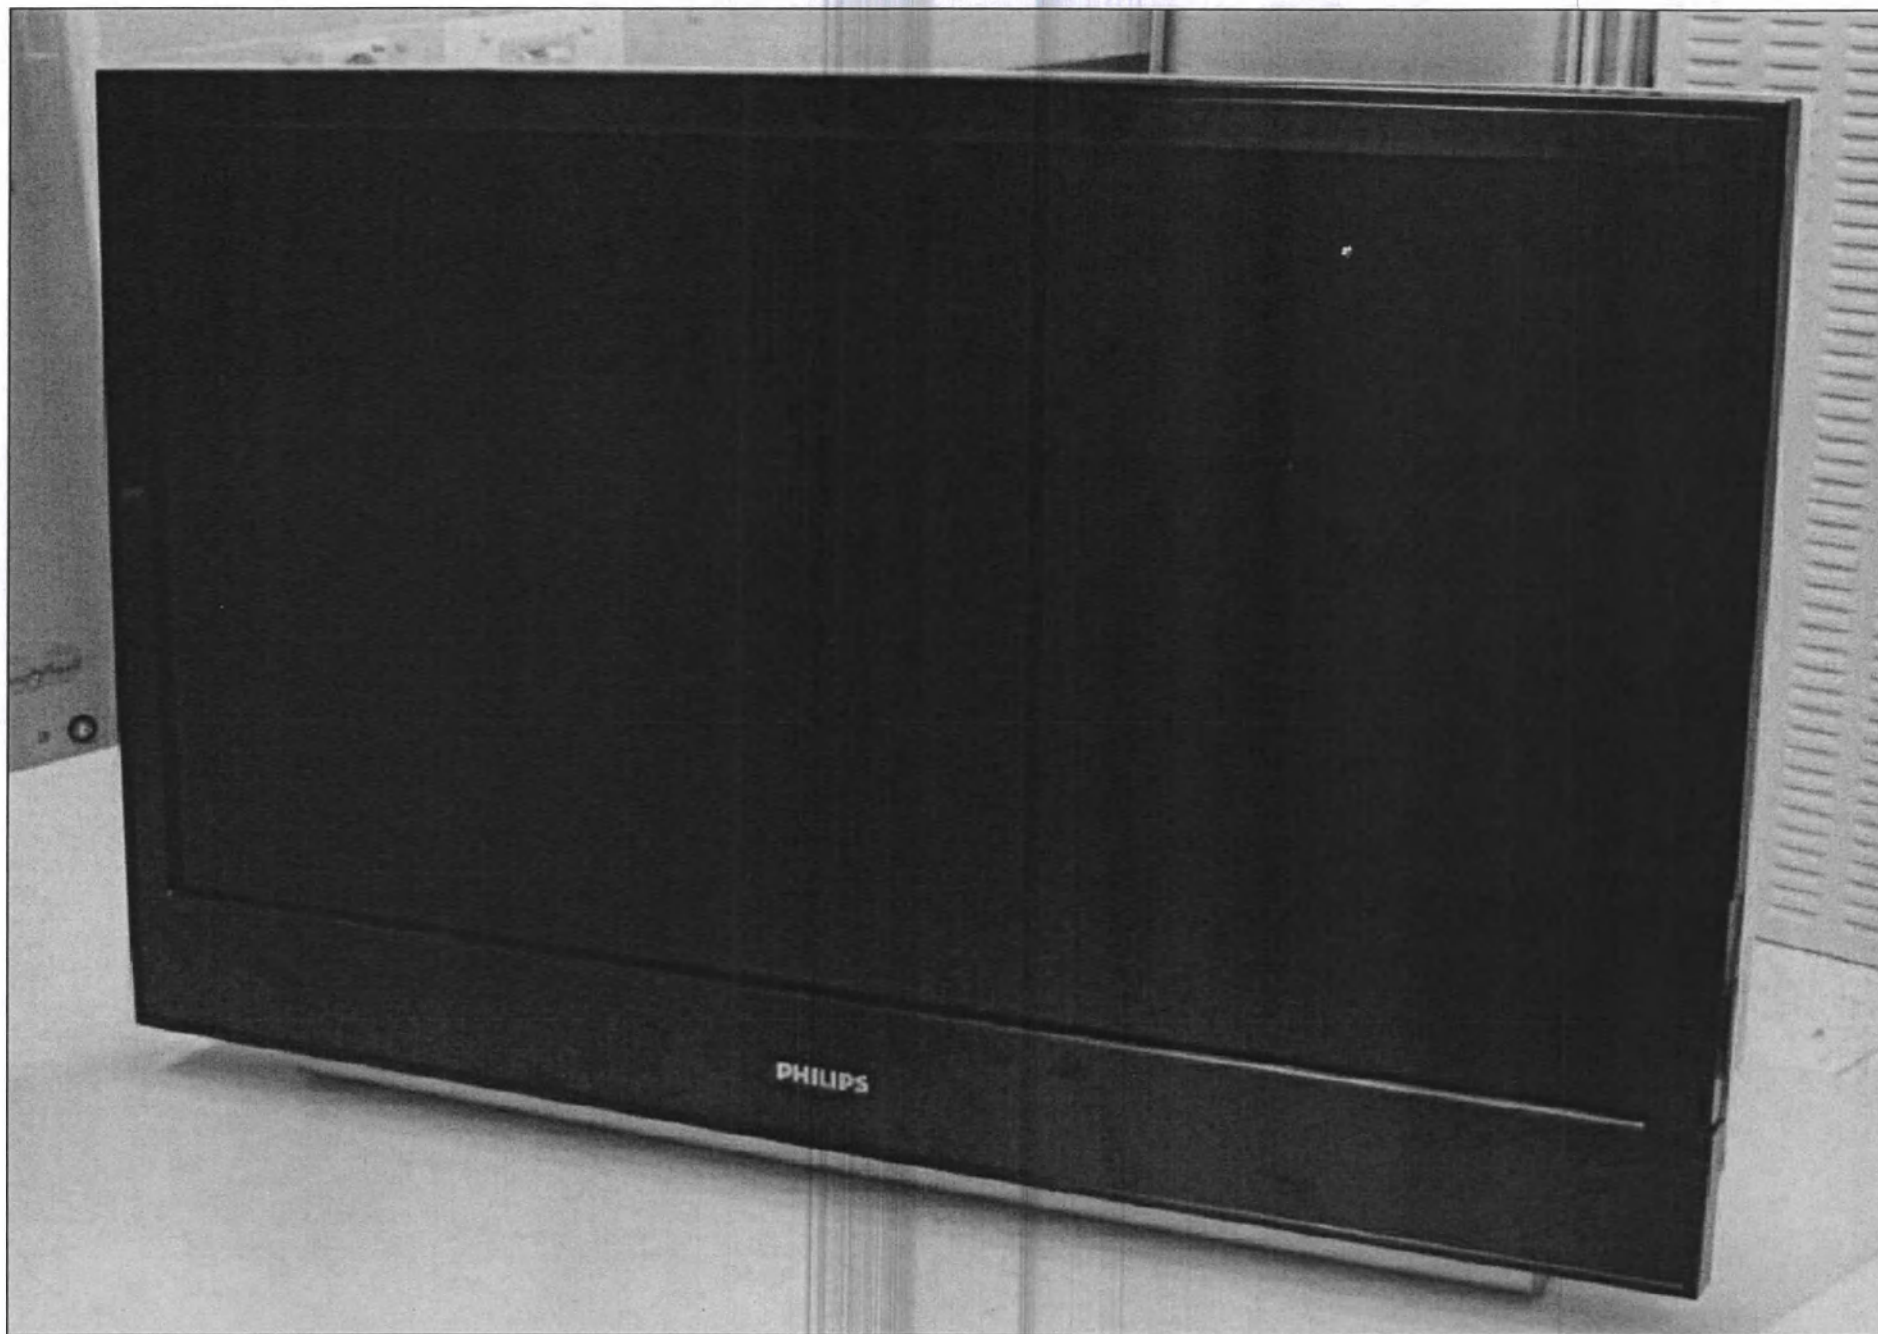

8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

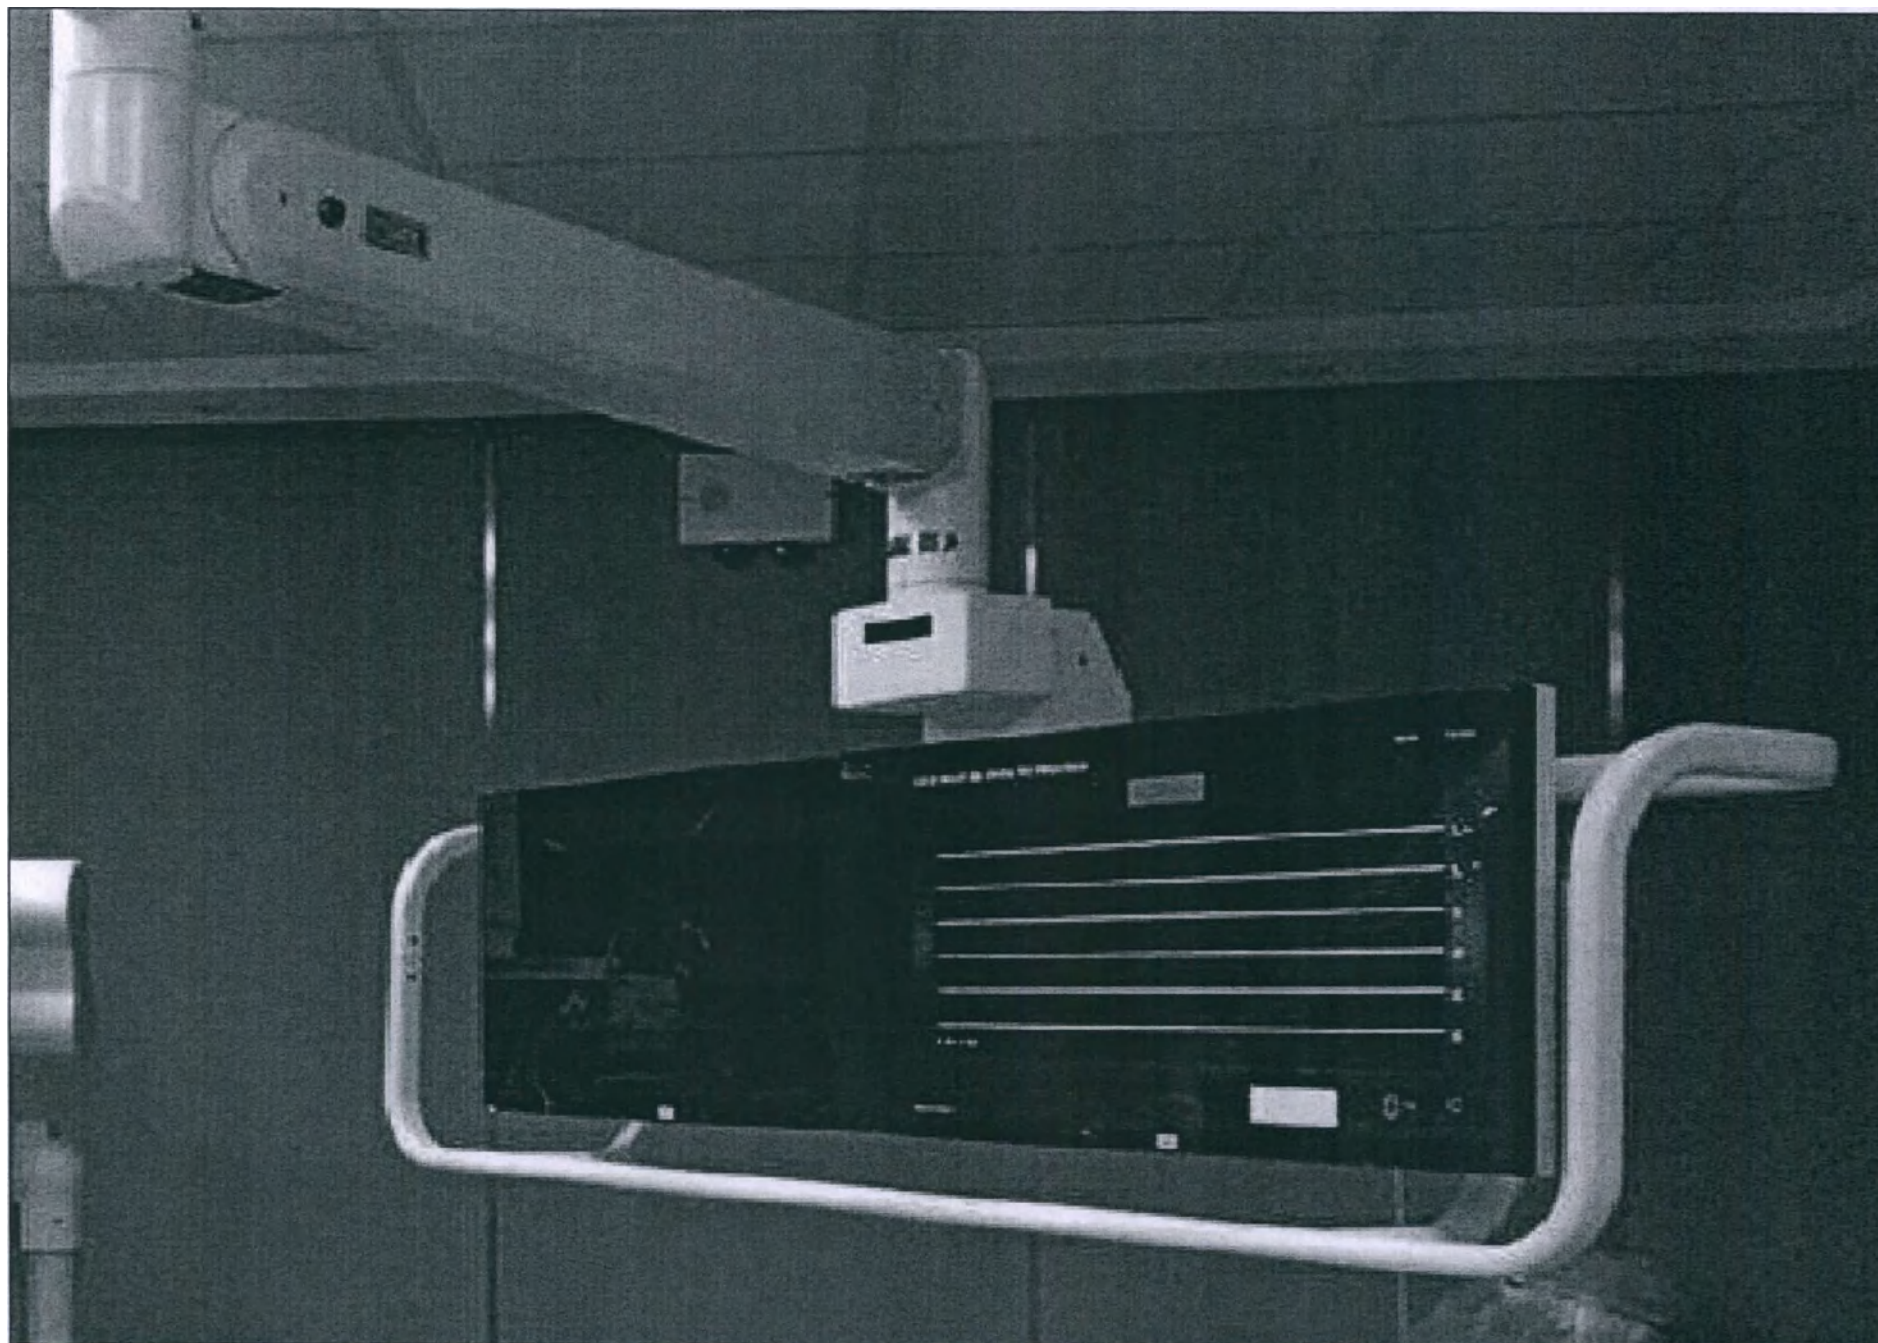


9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный




10.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.



10.6. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

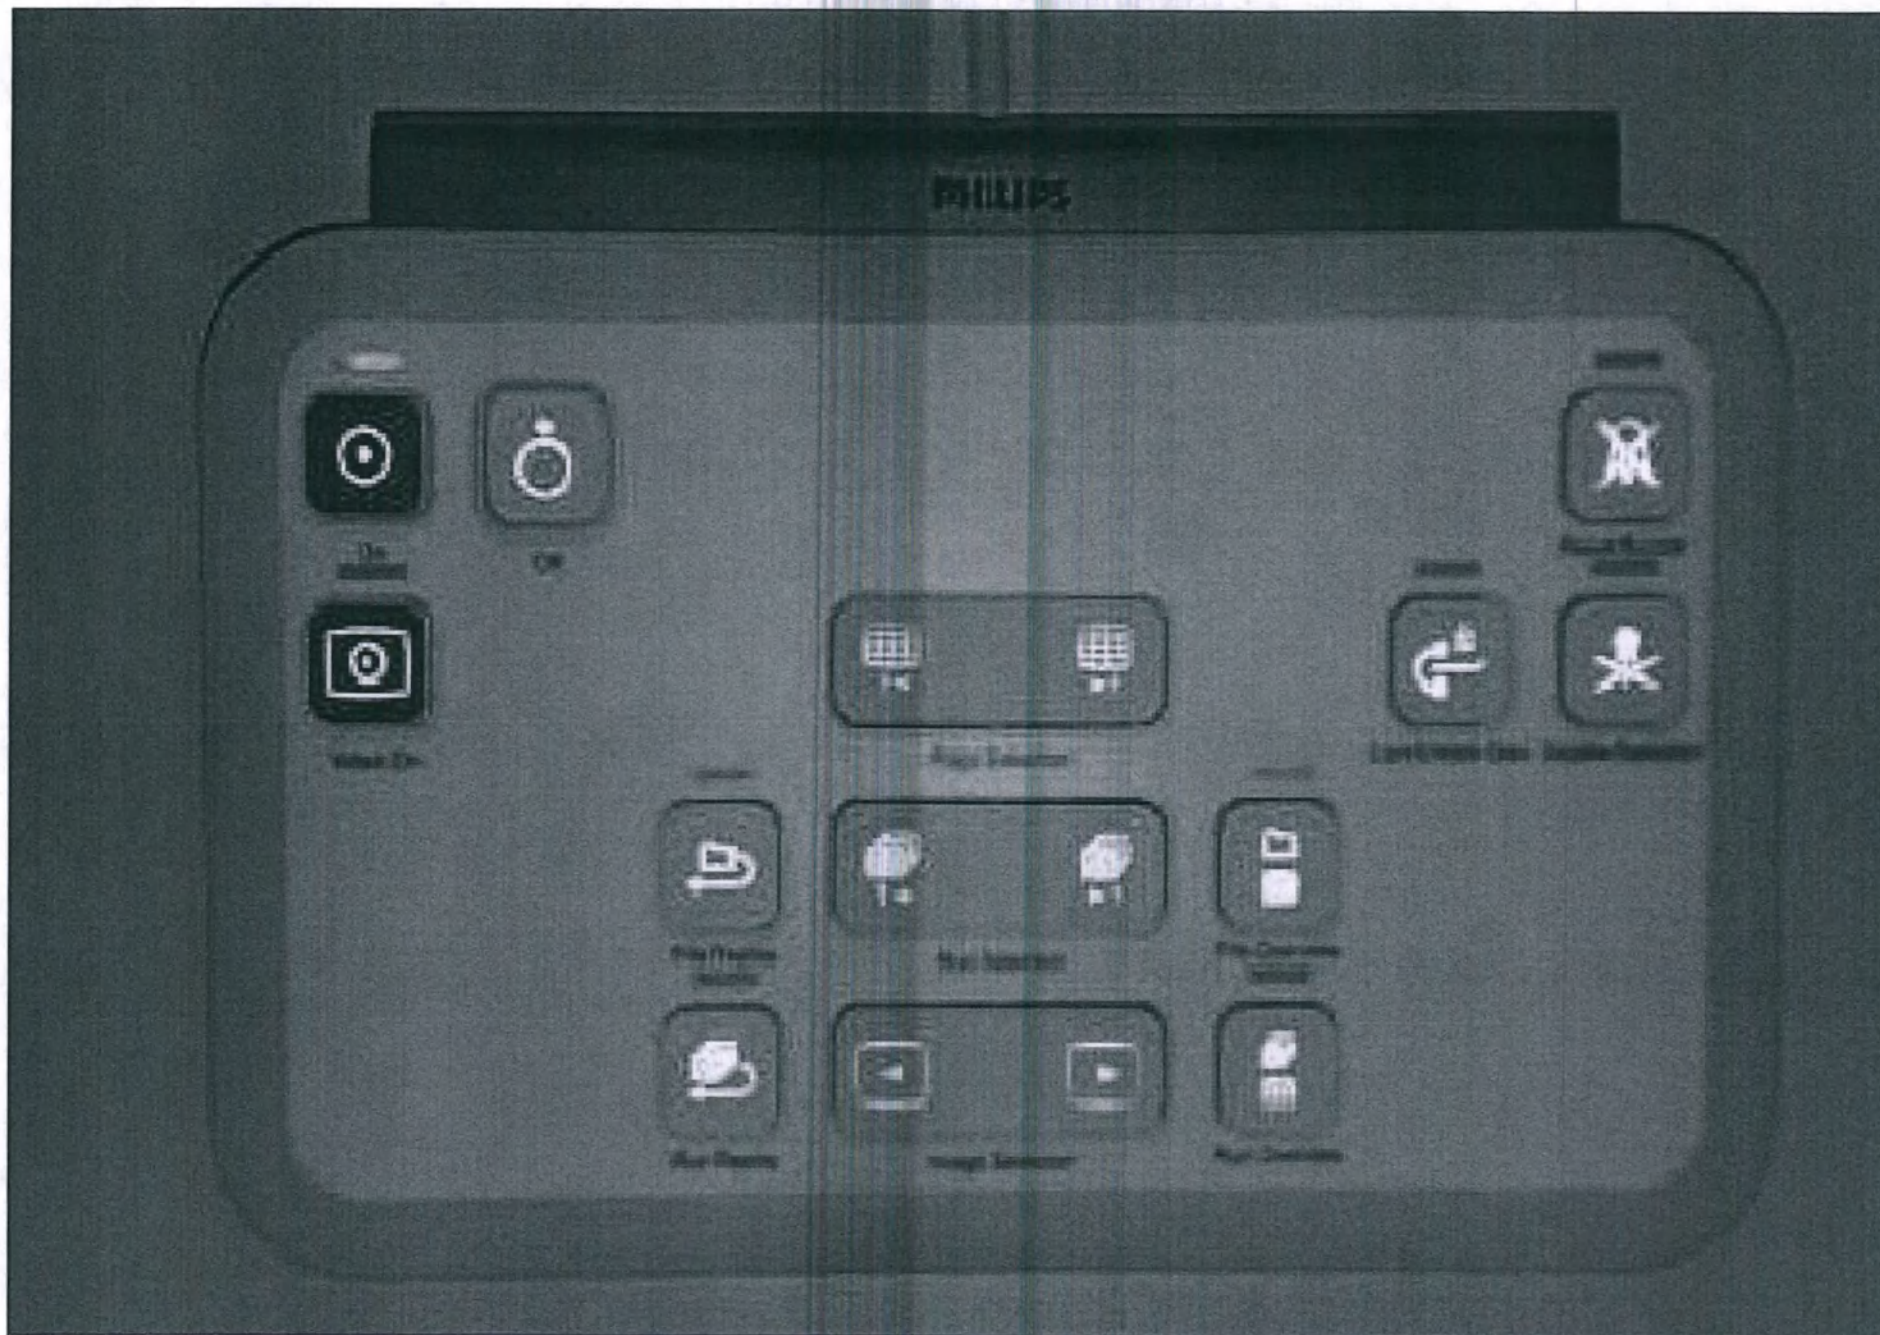


10.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

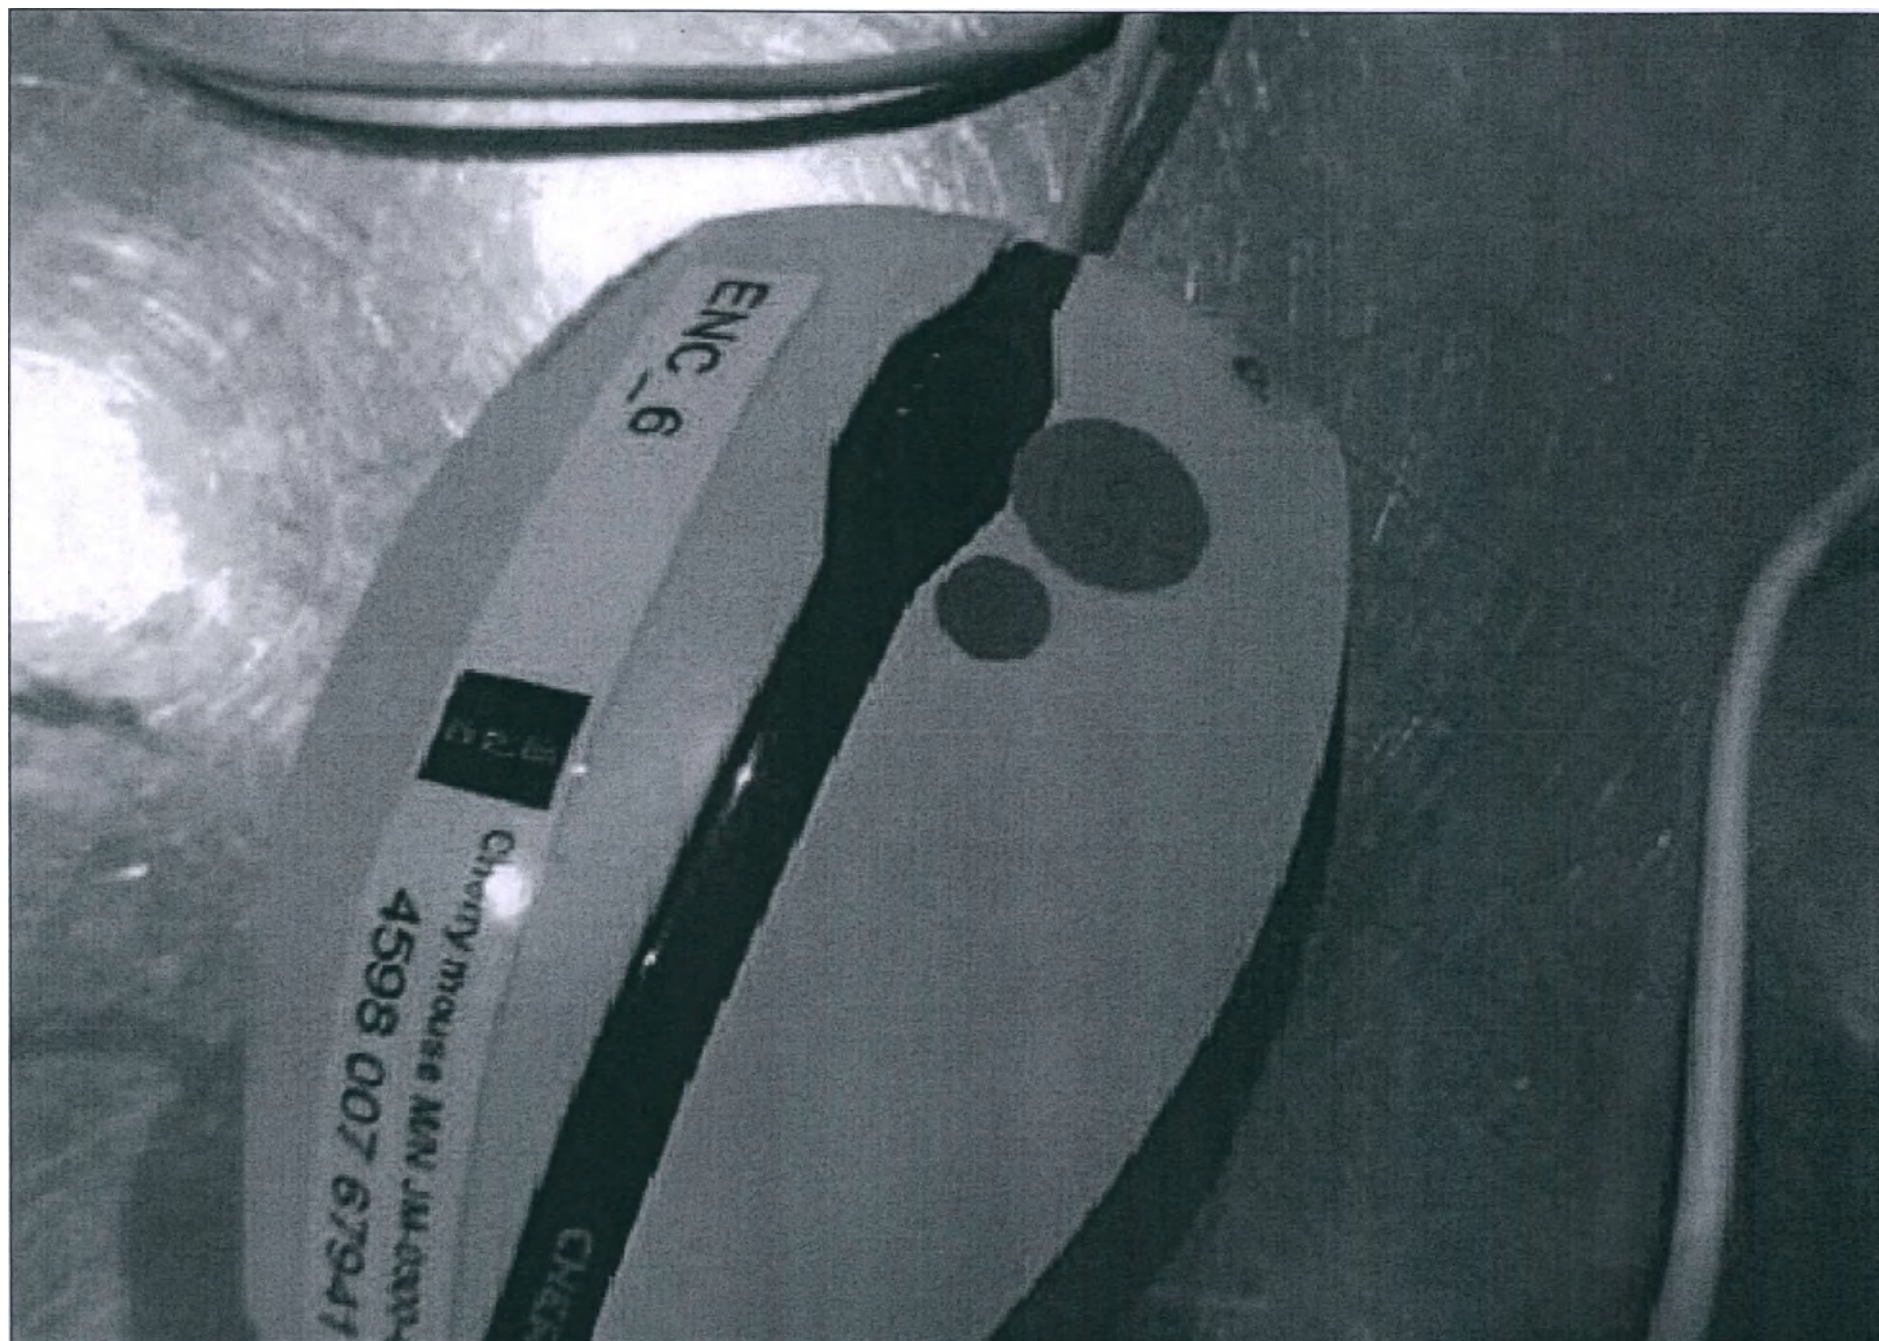


10.2. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.




10.д. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

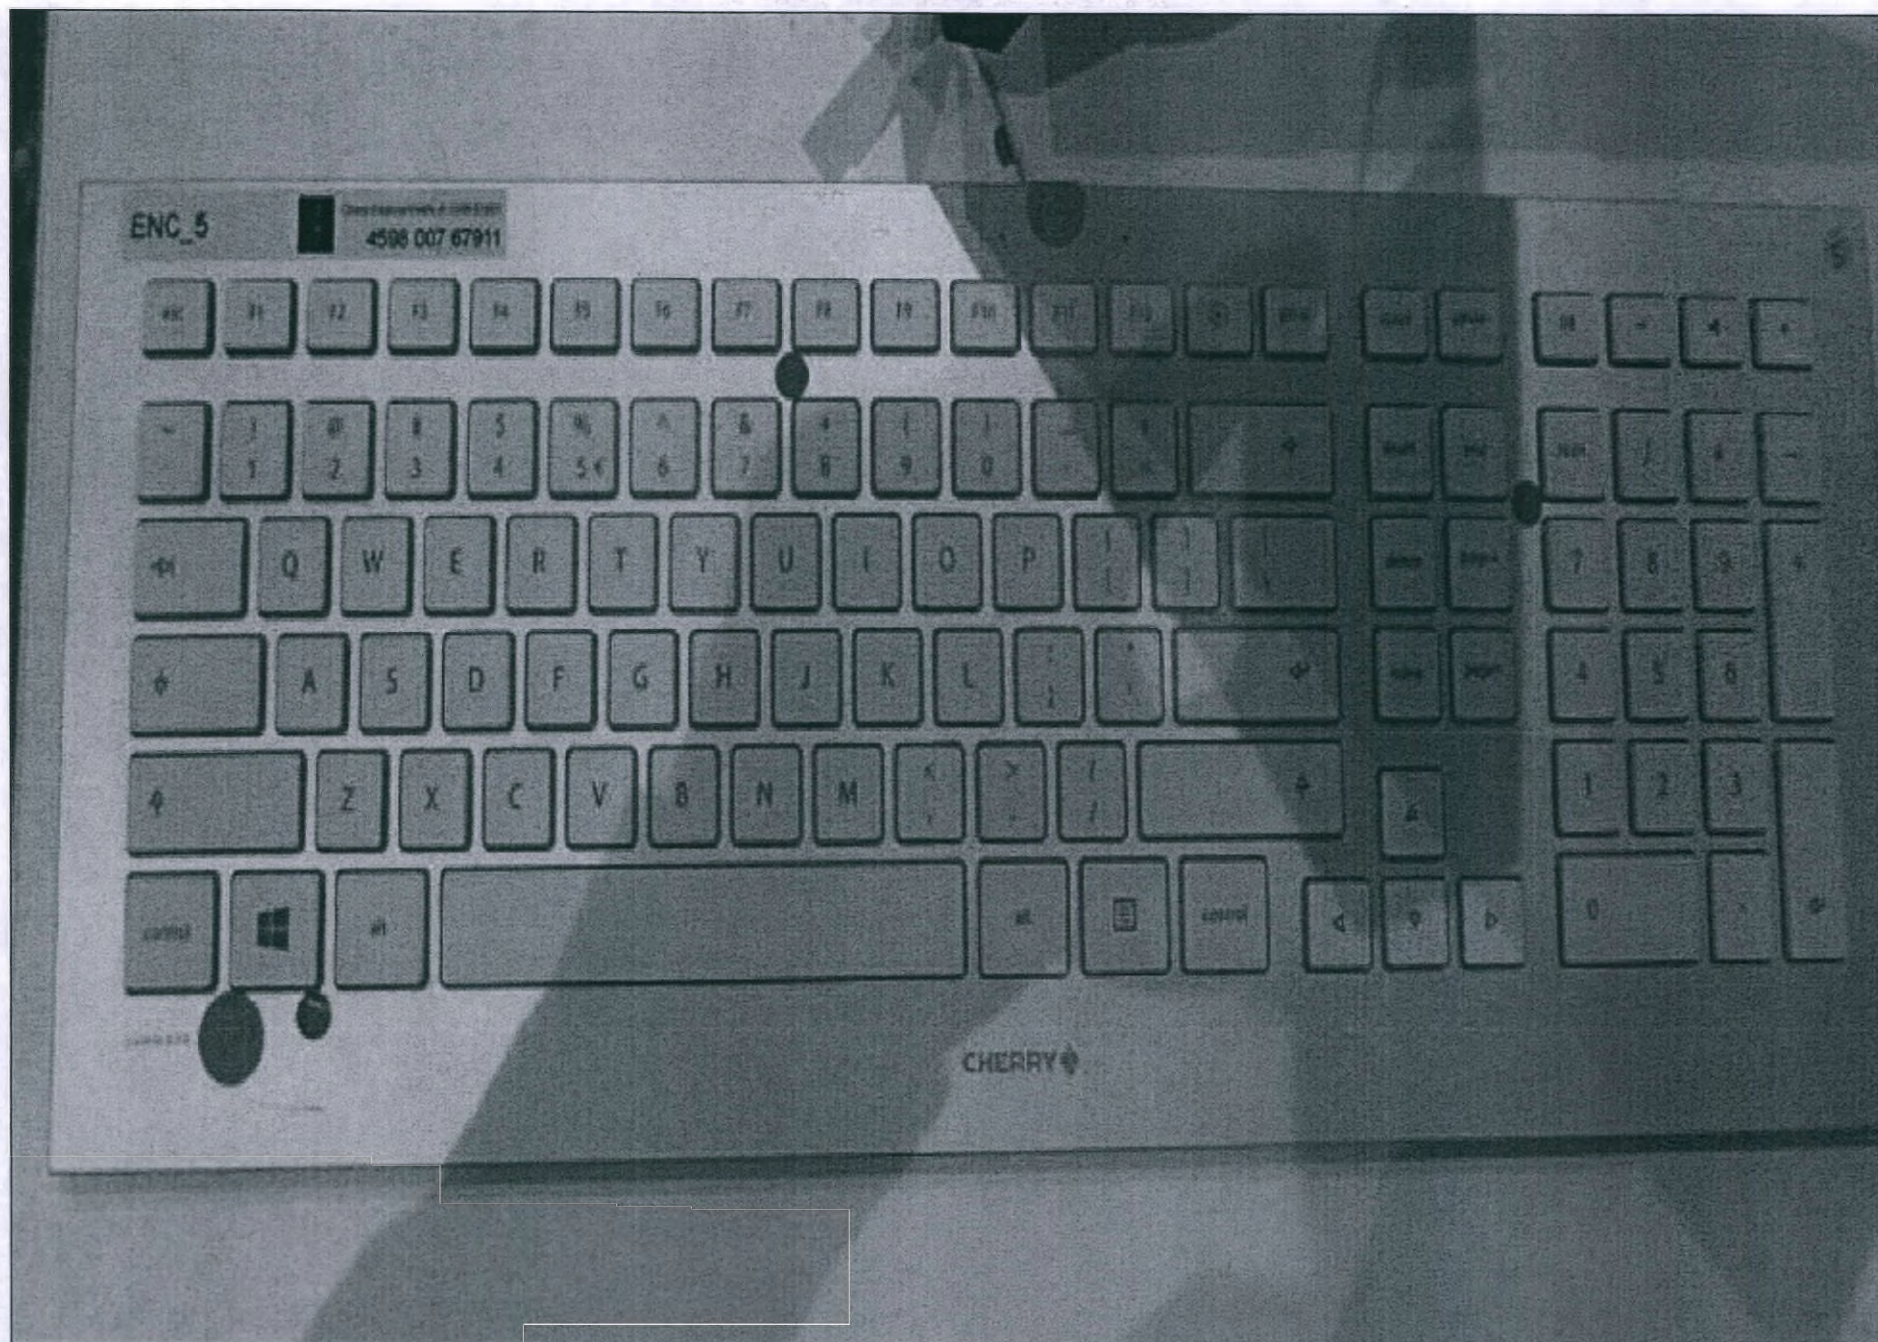


10.е. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

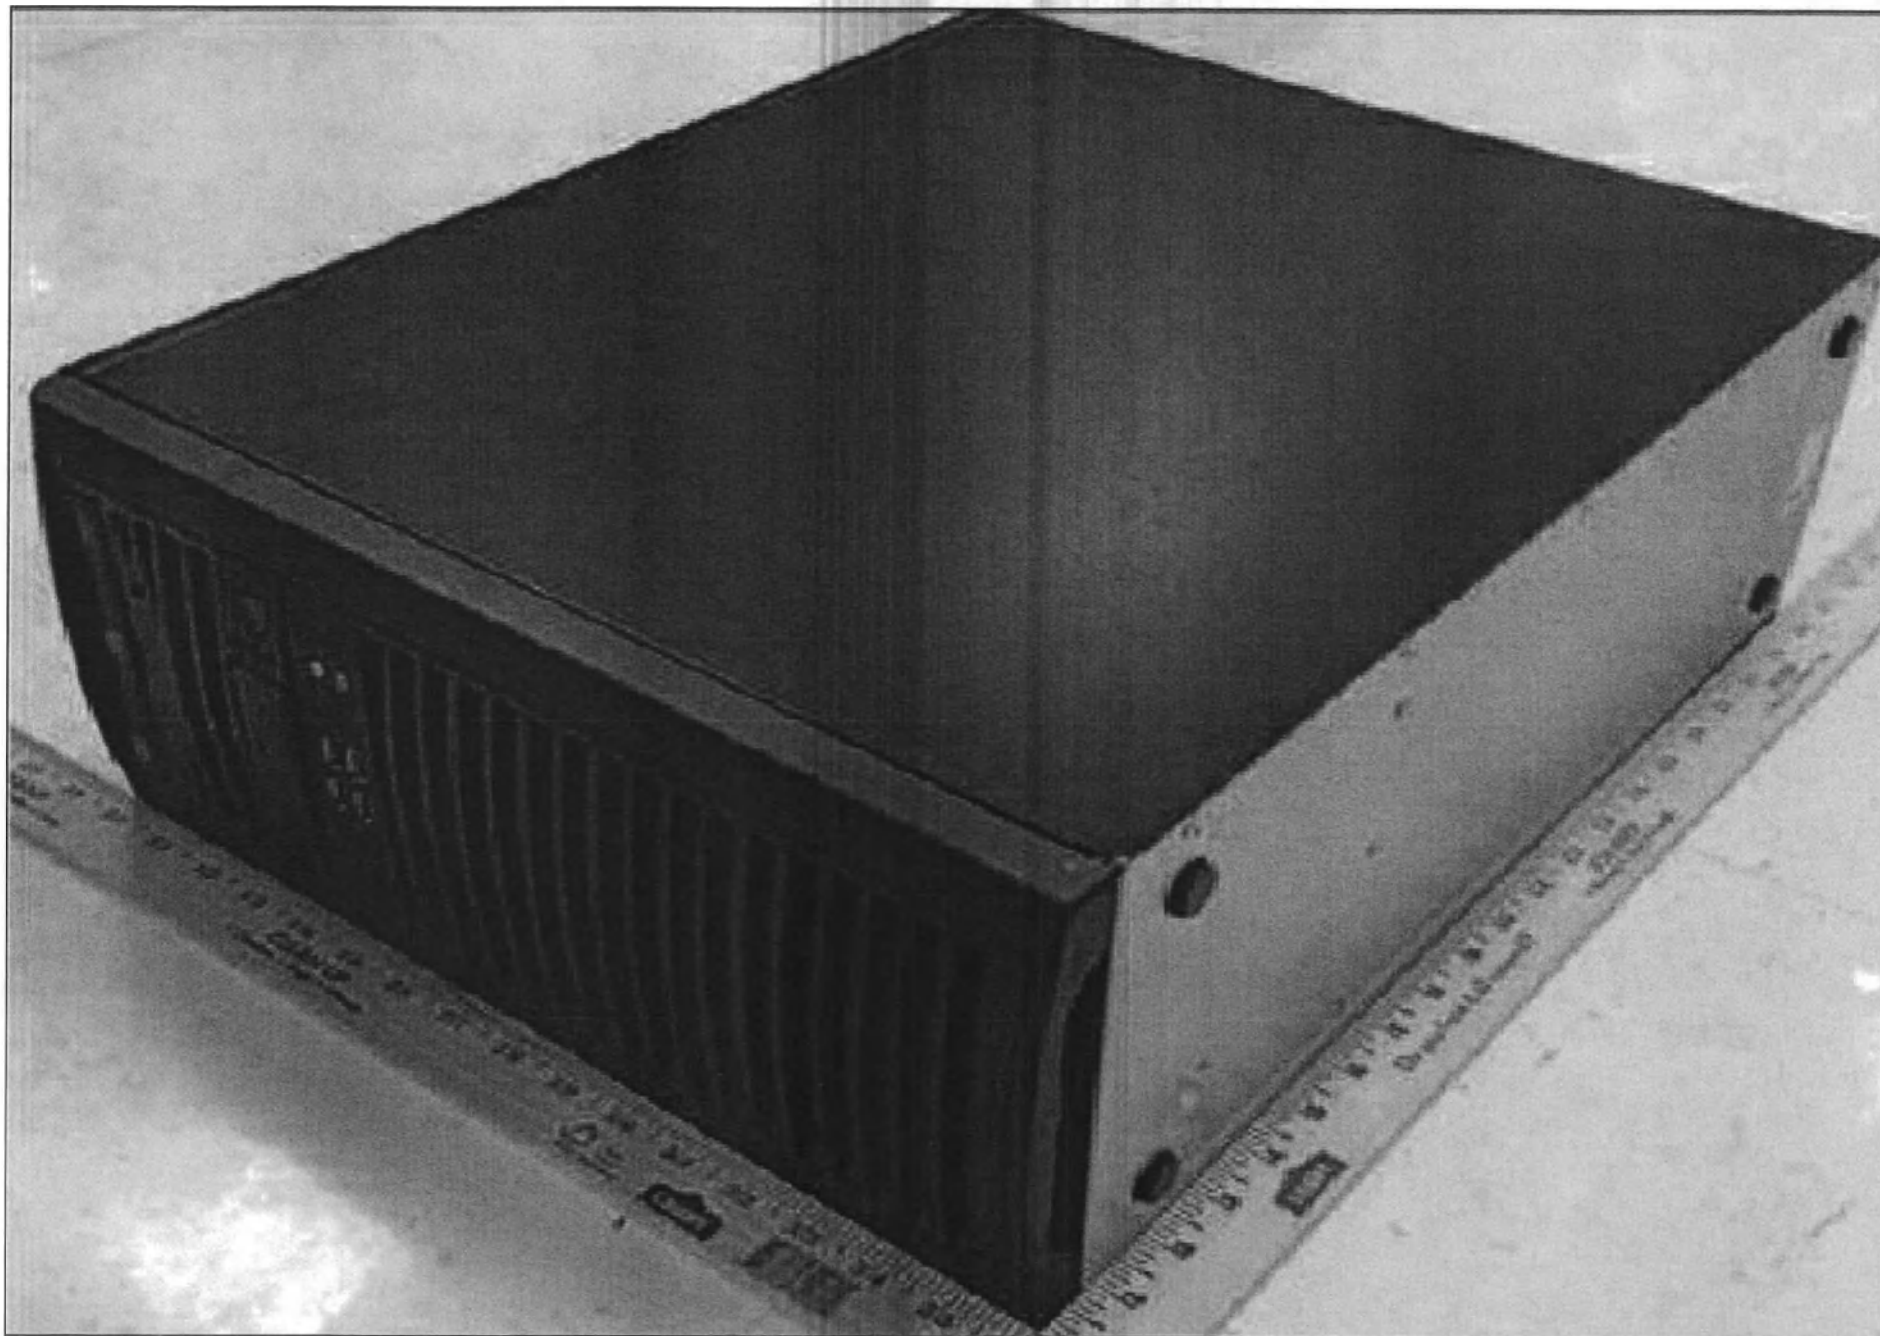


10.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

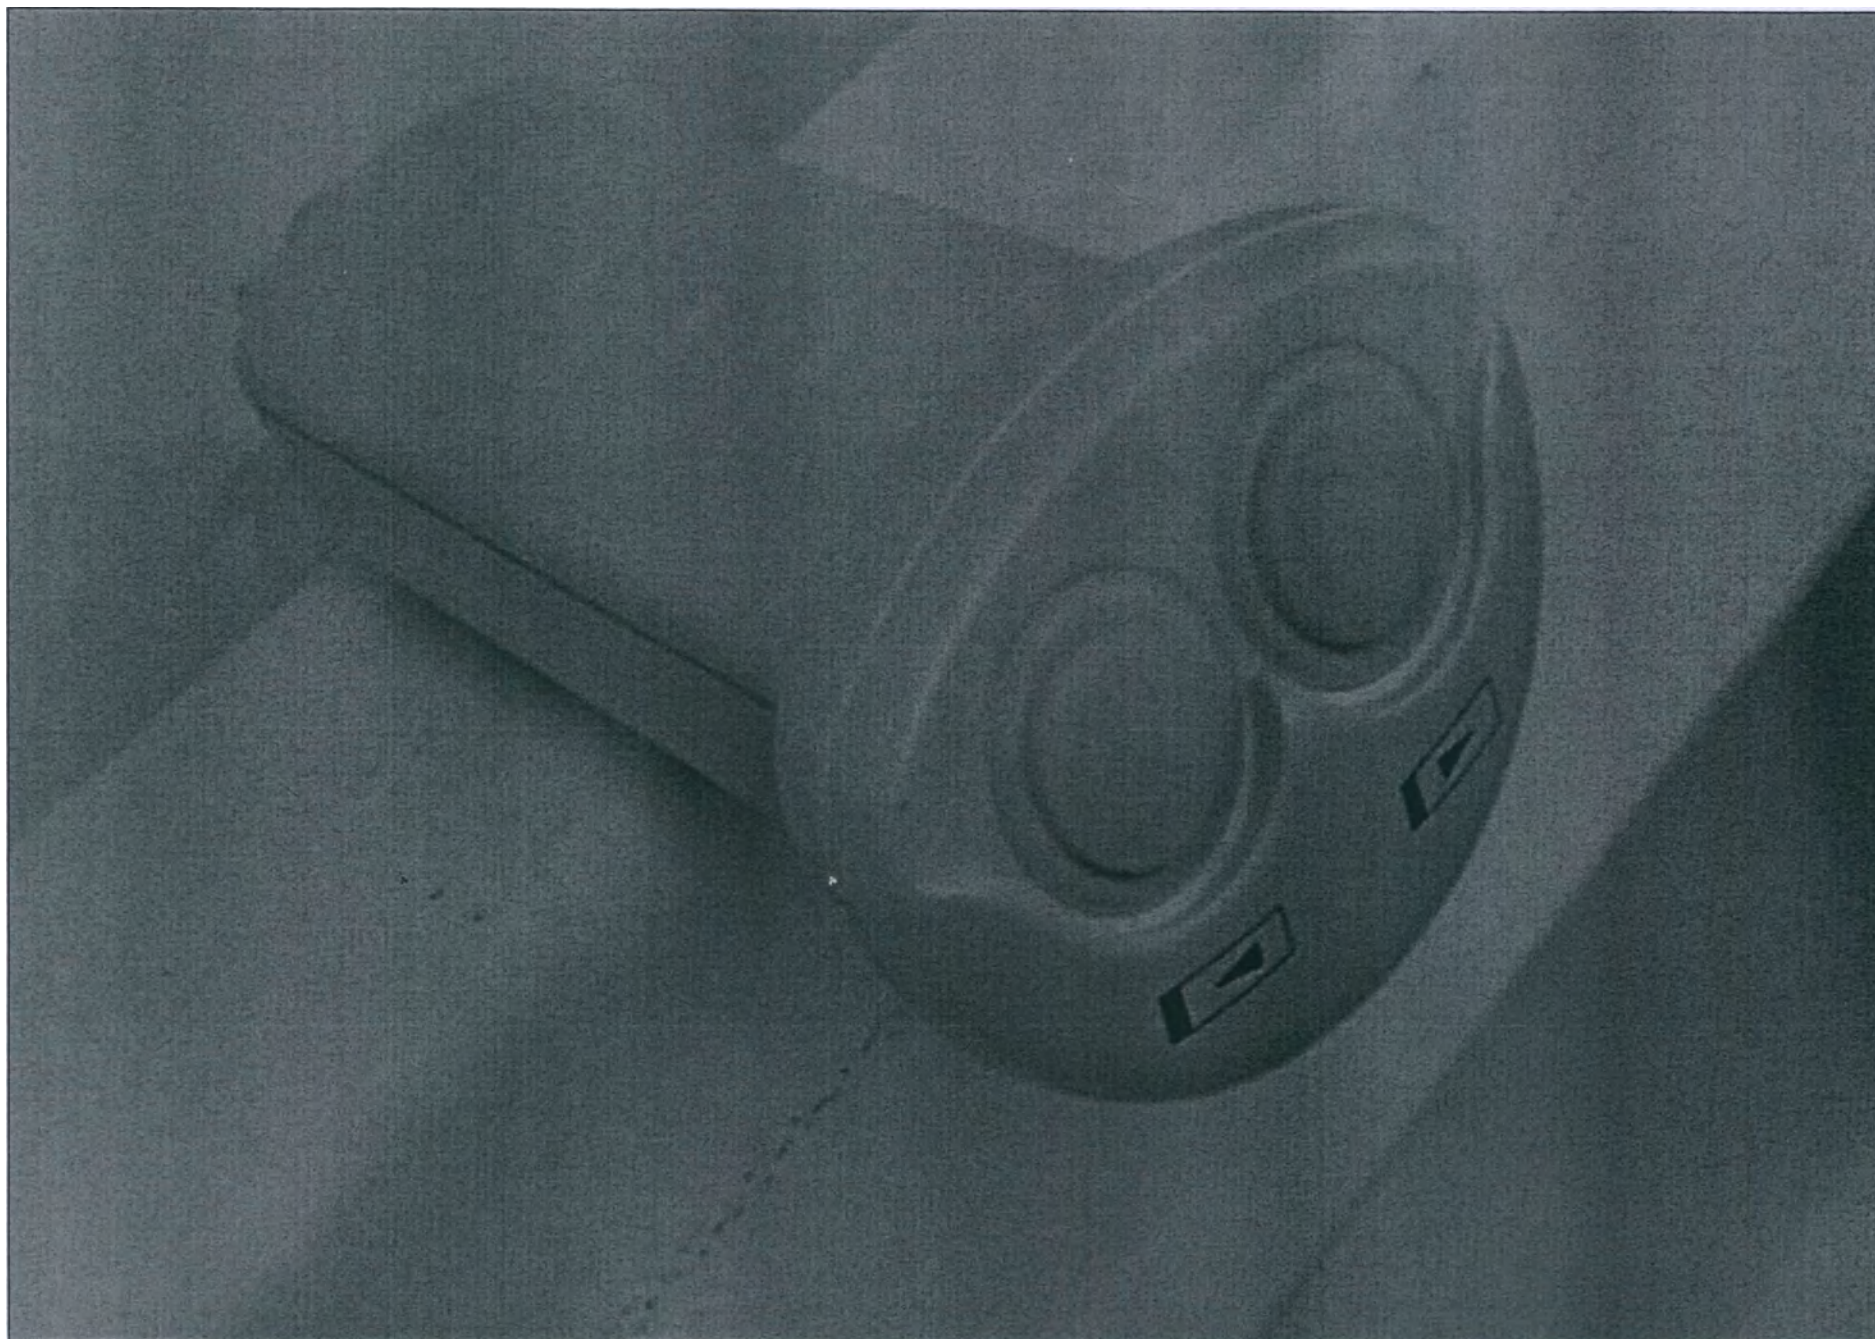


11. Ручной переключатель сдвига.

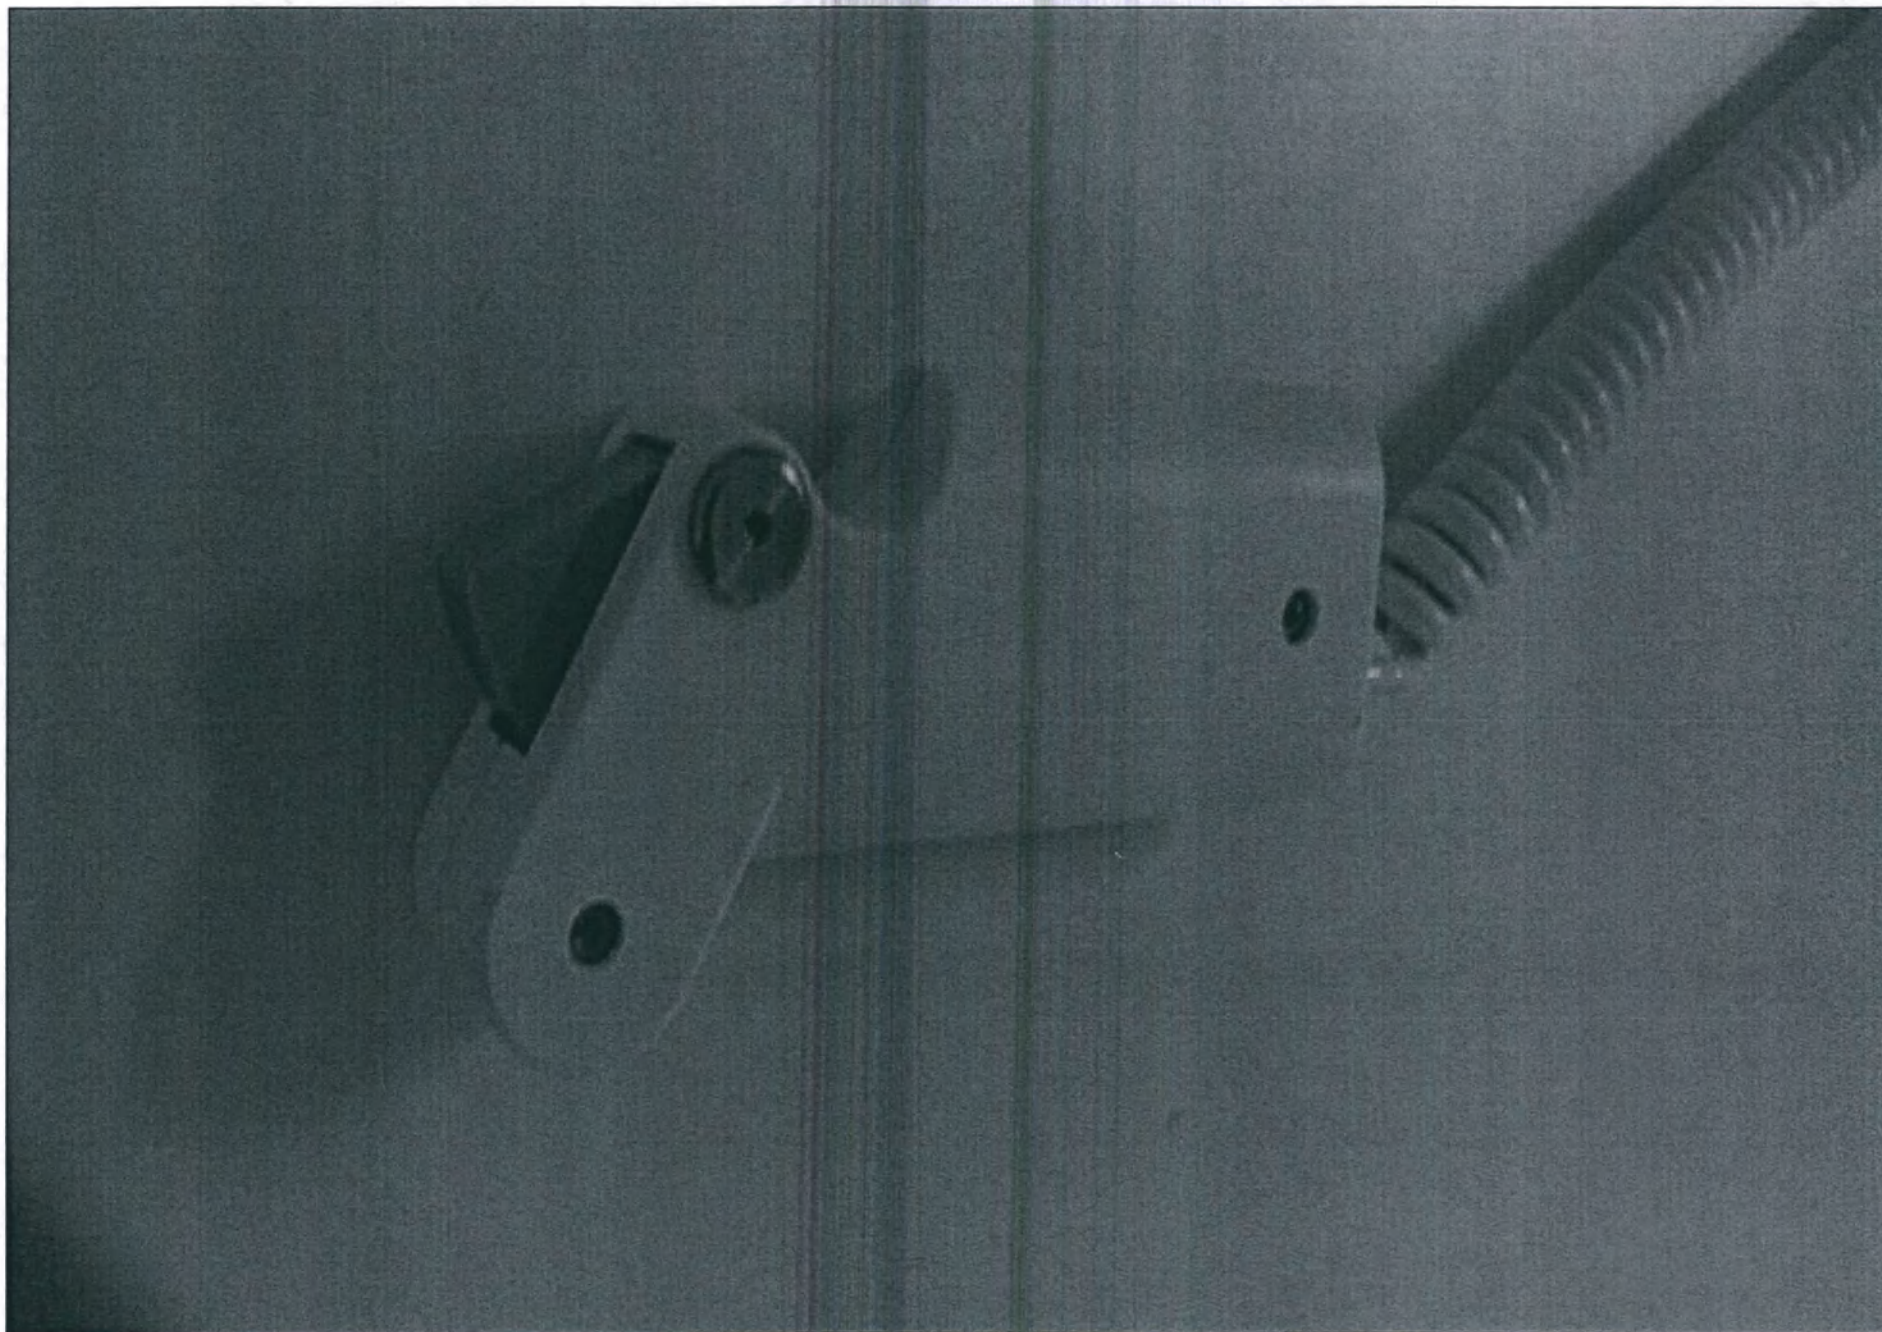


12. Регулятор скорости.

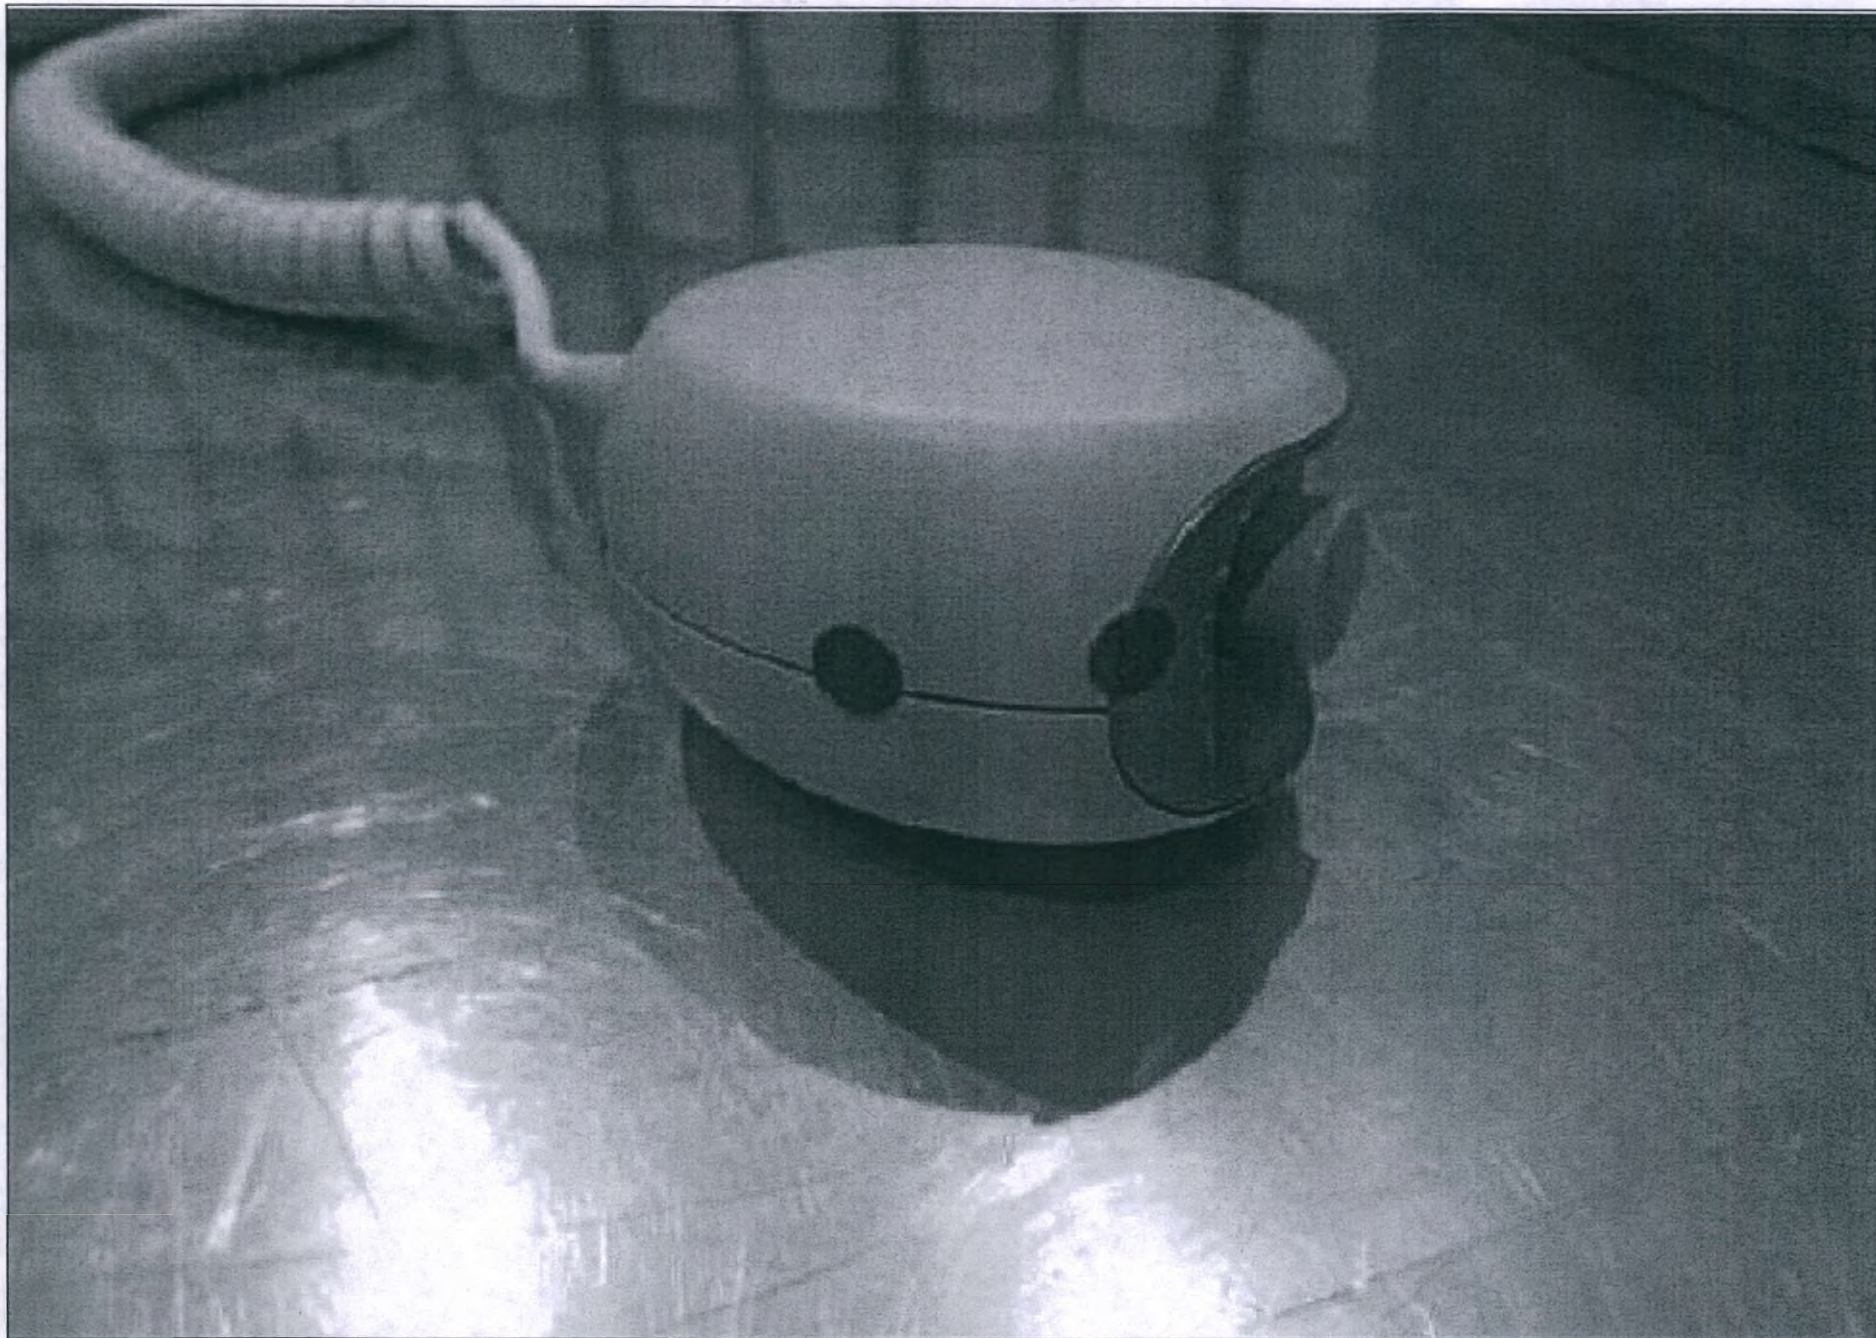


13. Ручной переключатель экспозиции.

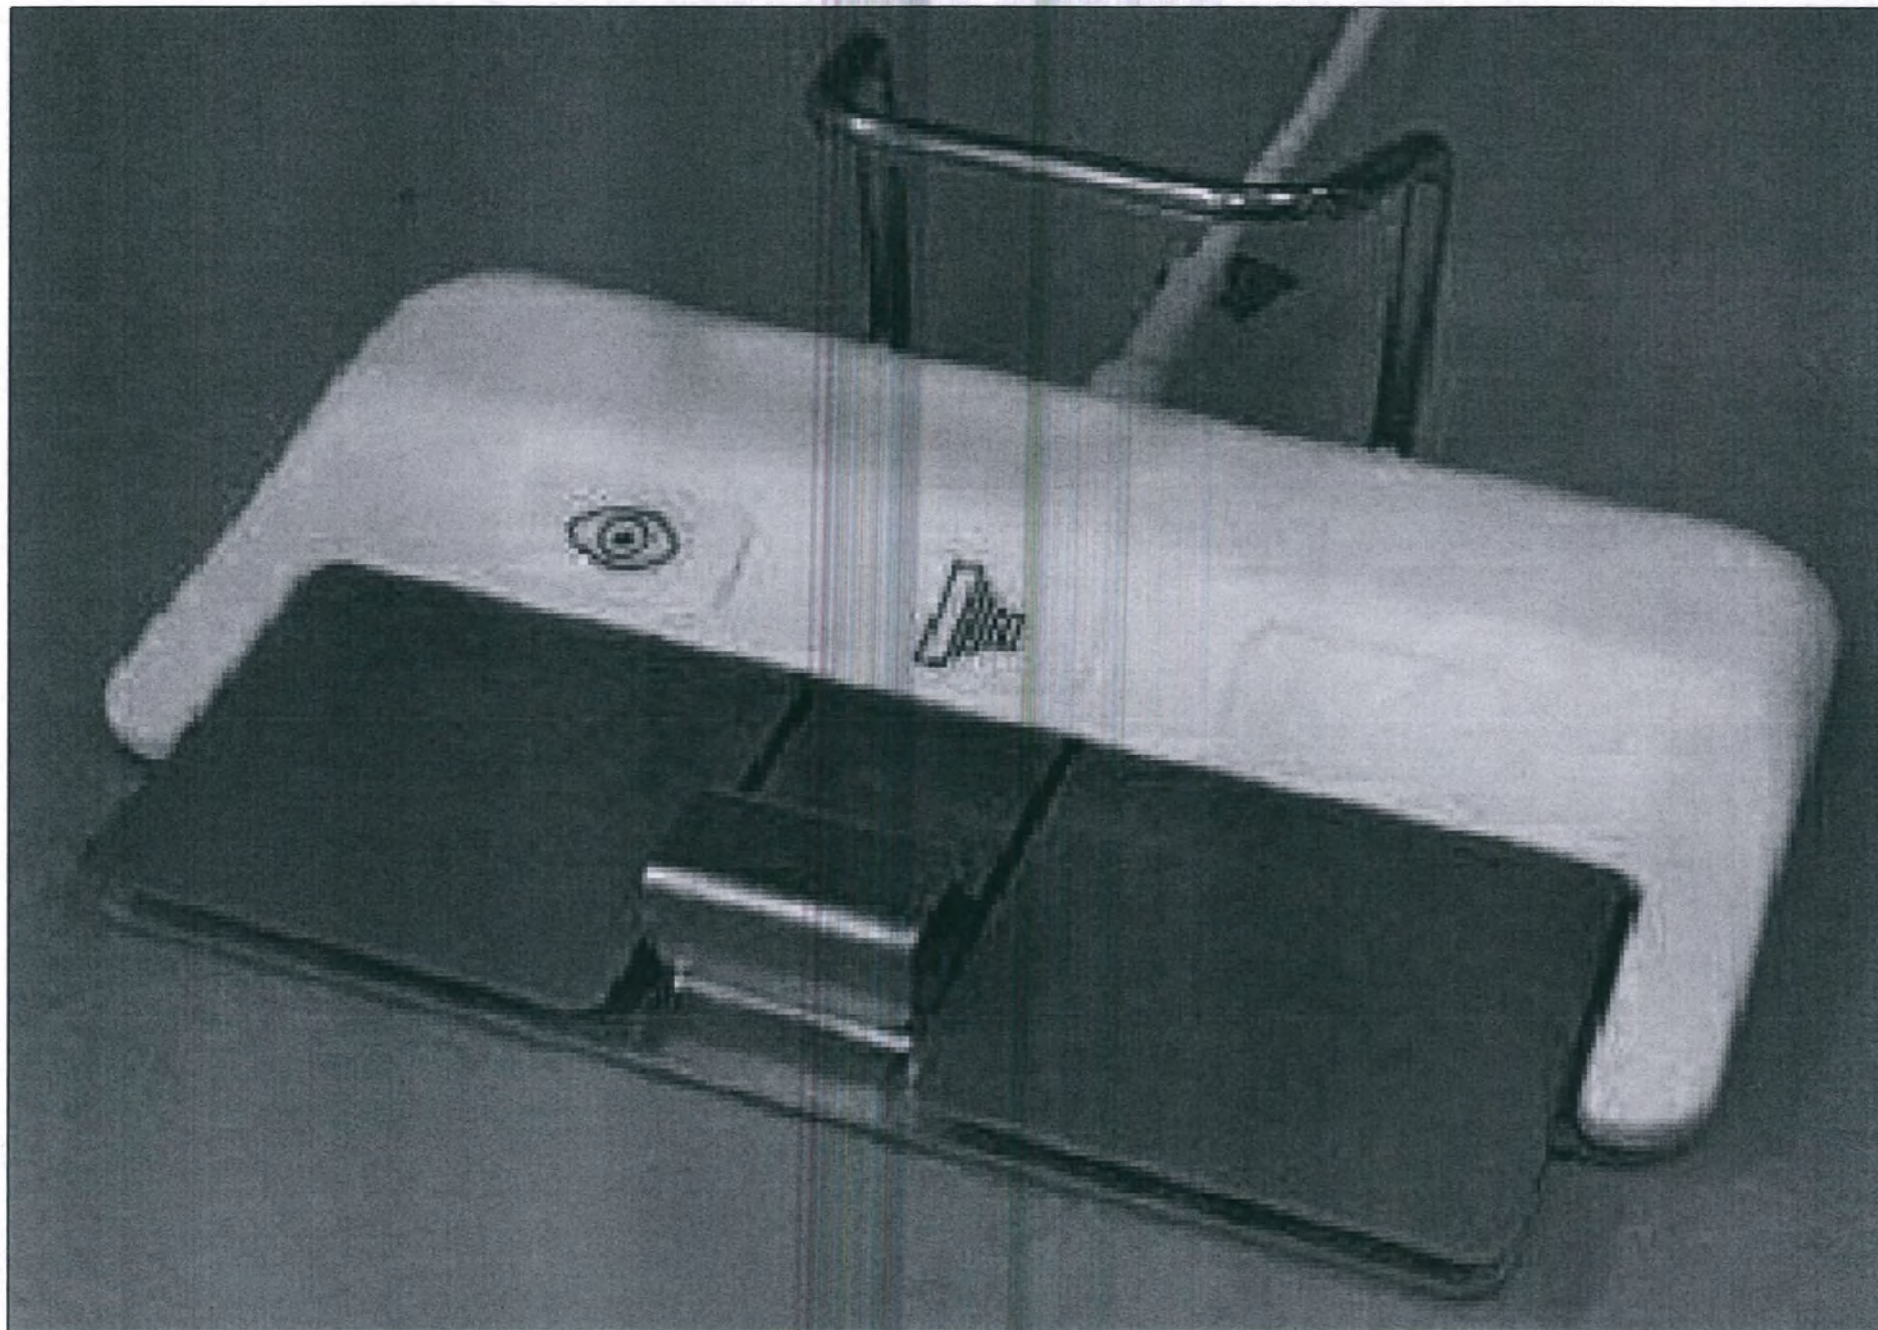


14. Ножной переключатель, не более 2 шт.

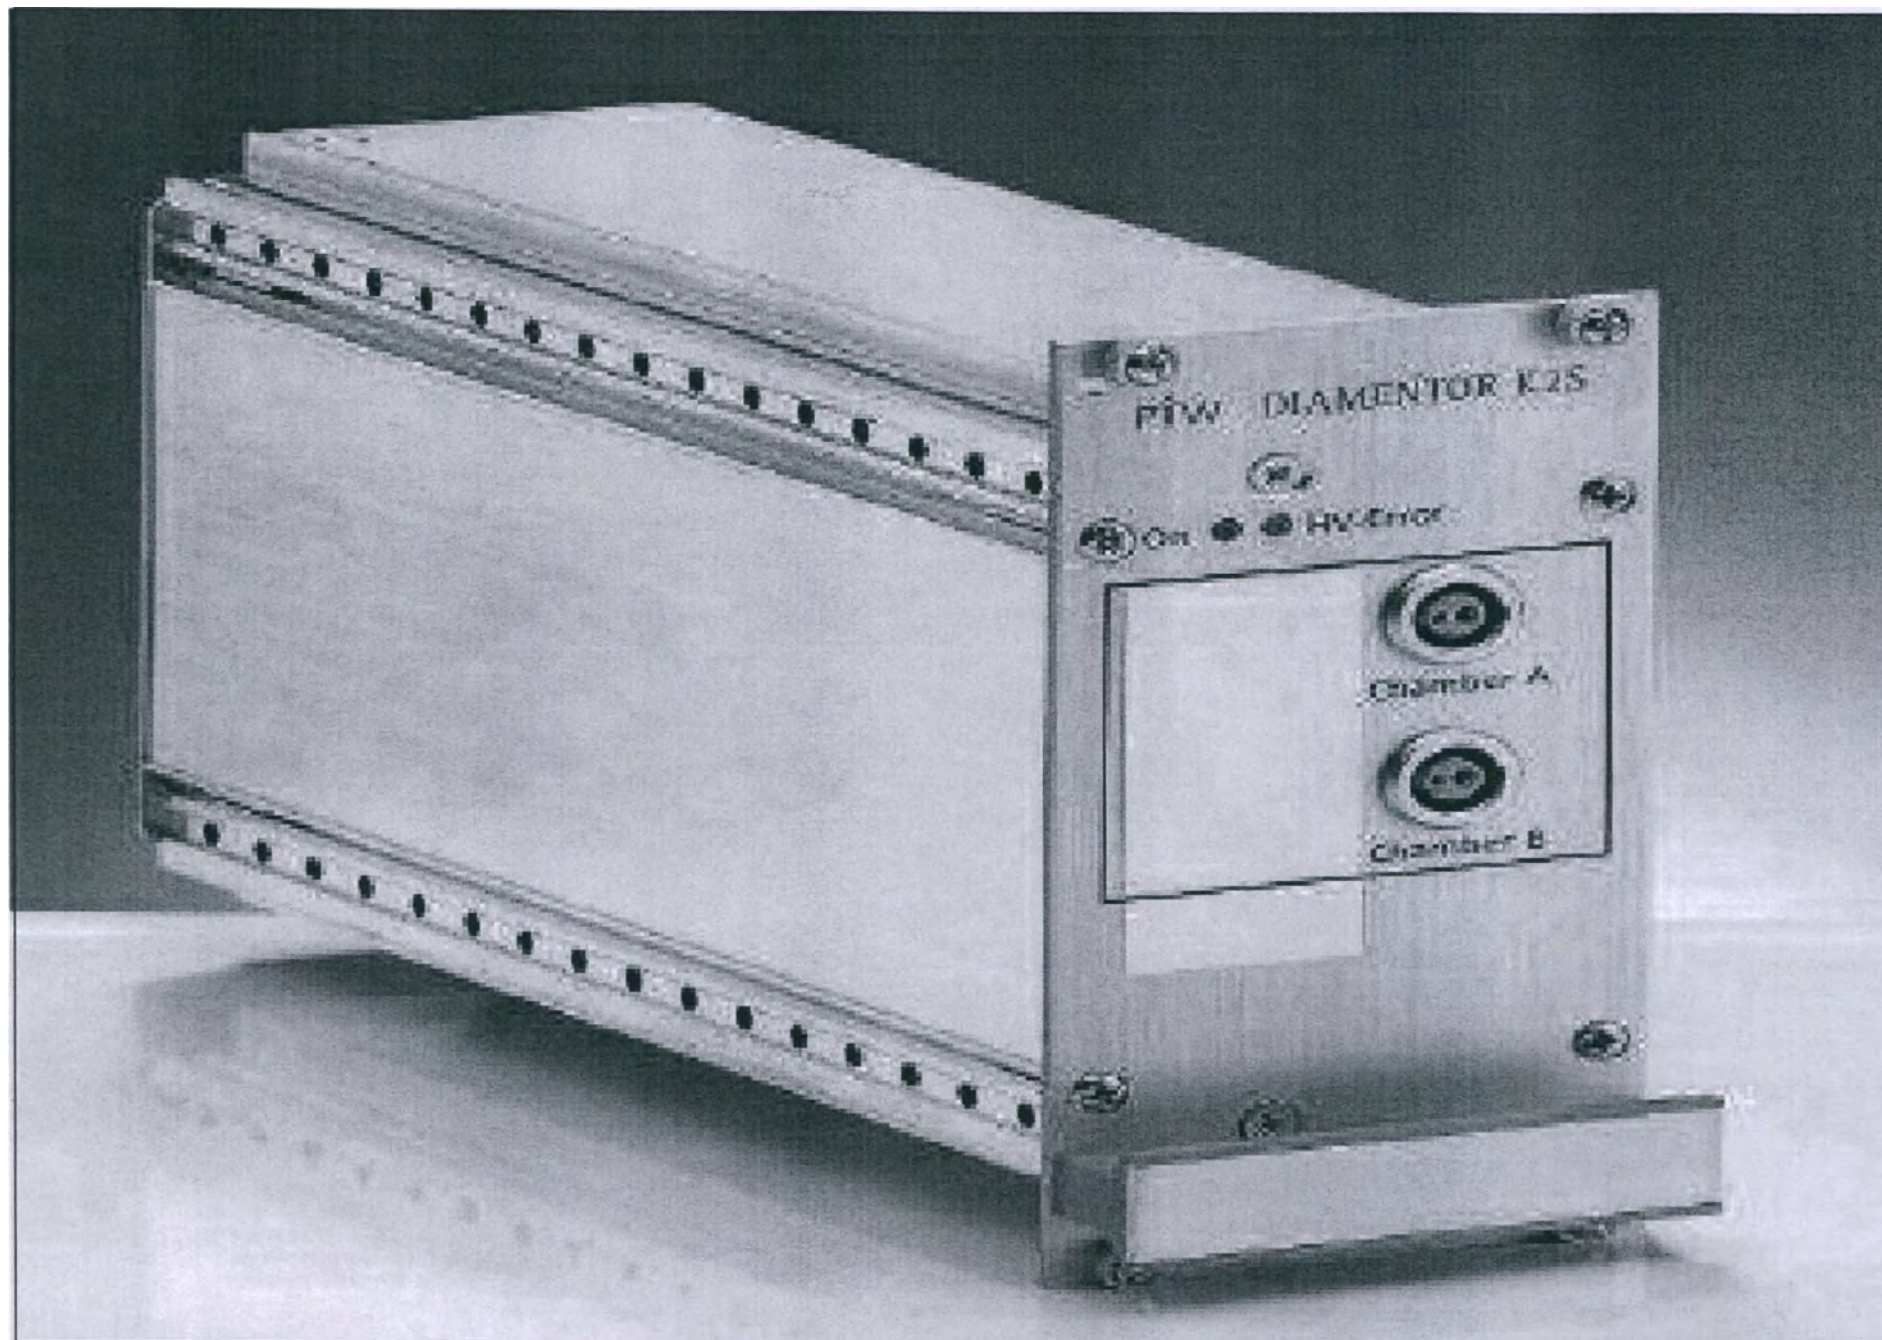


15.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

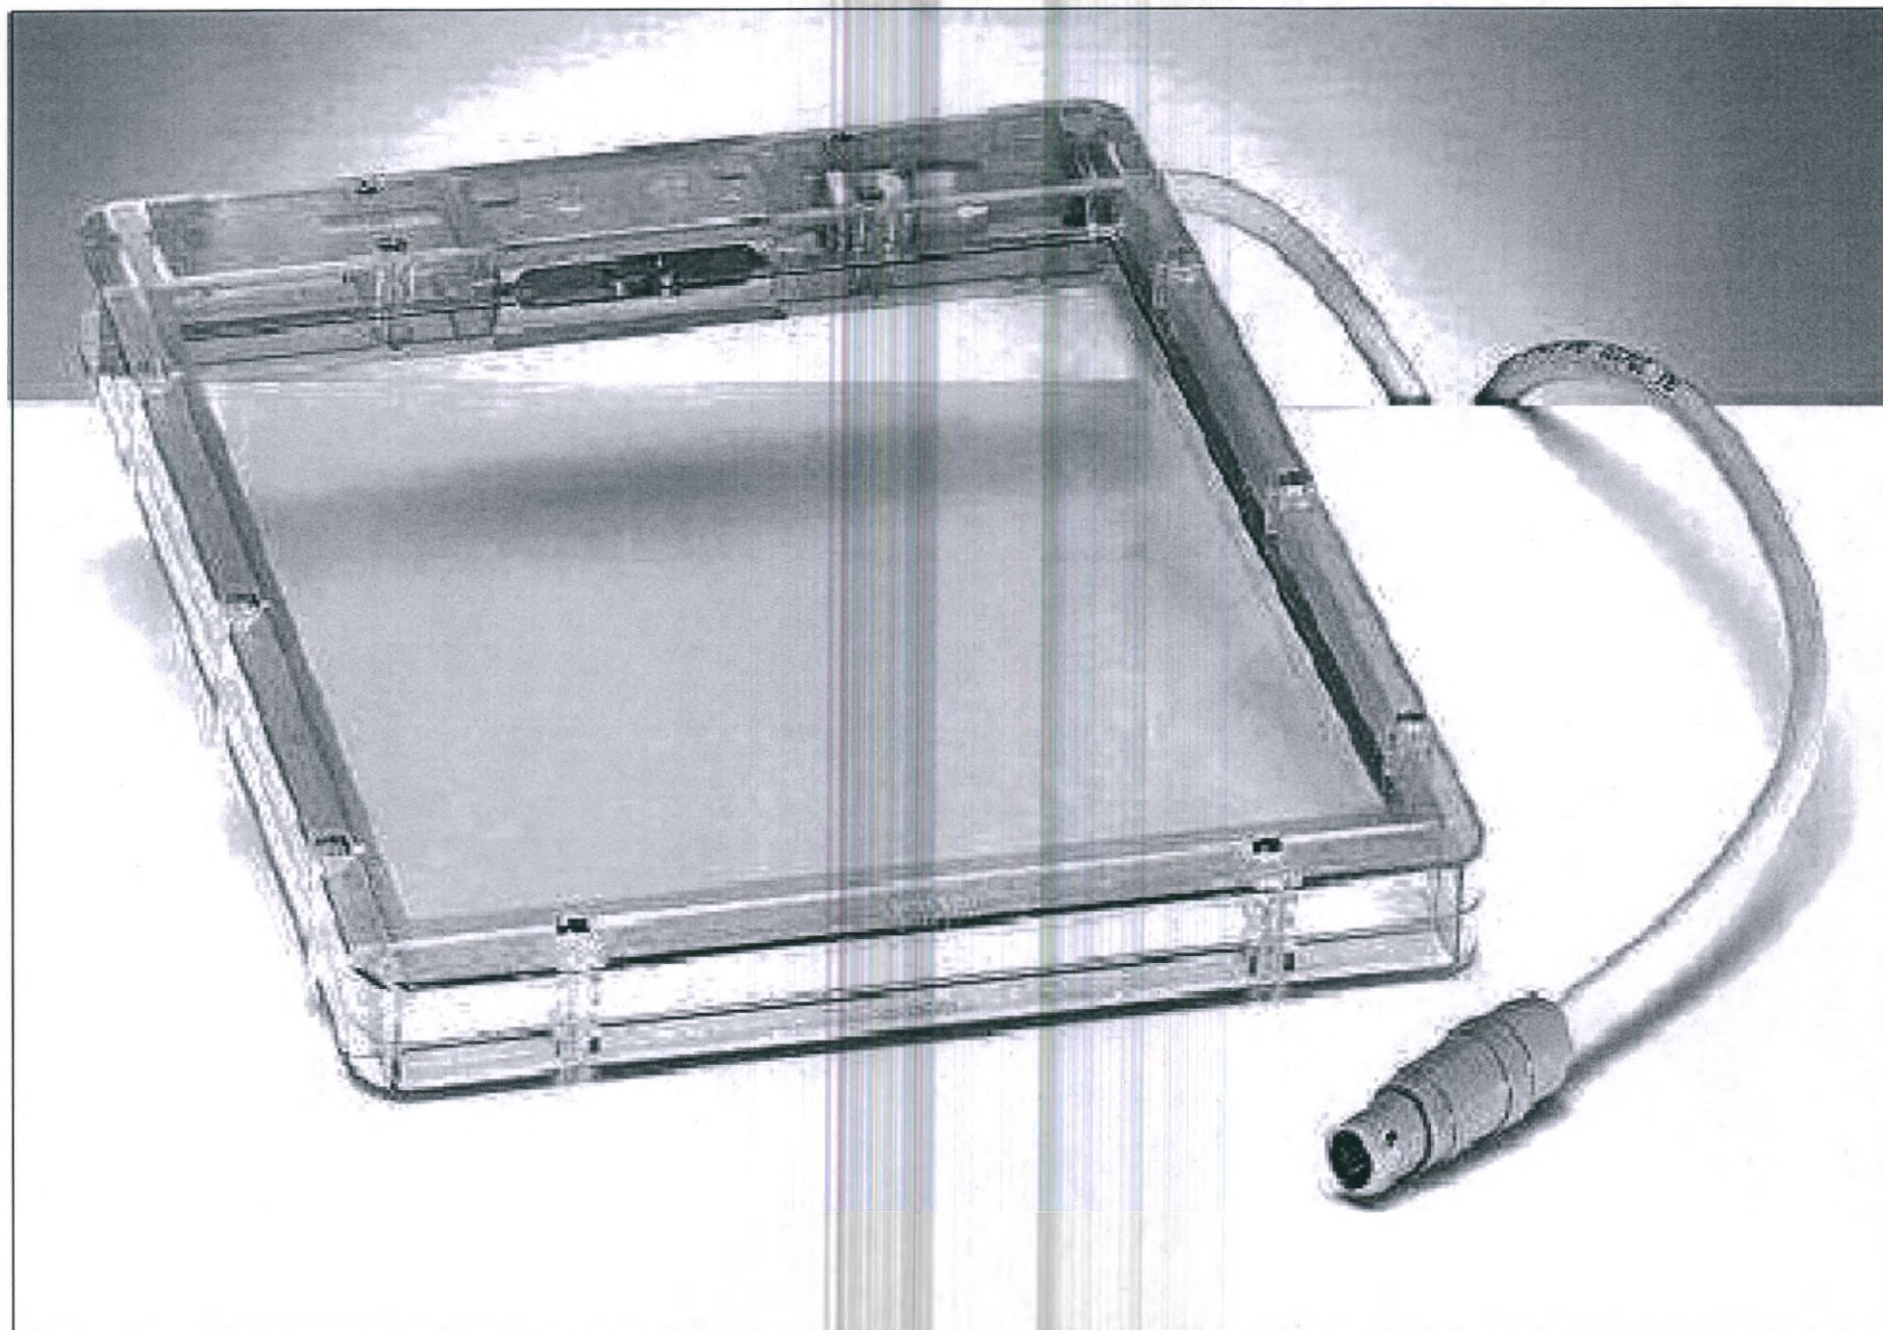


15.6. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДПК-1* или *ДПК-1М*.

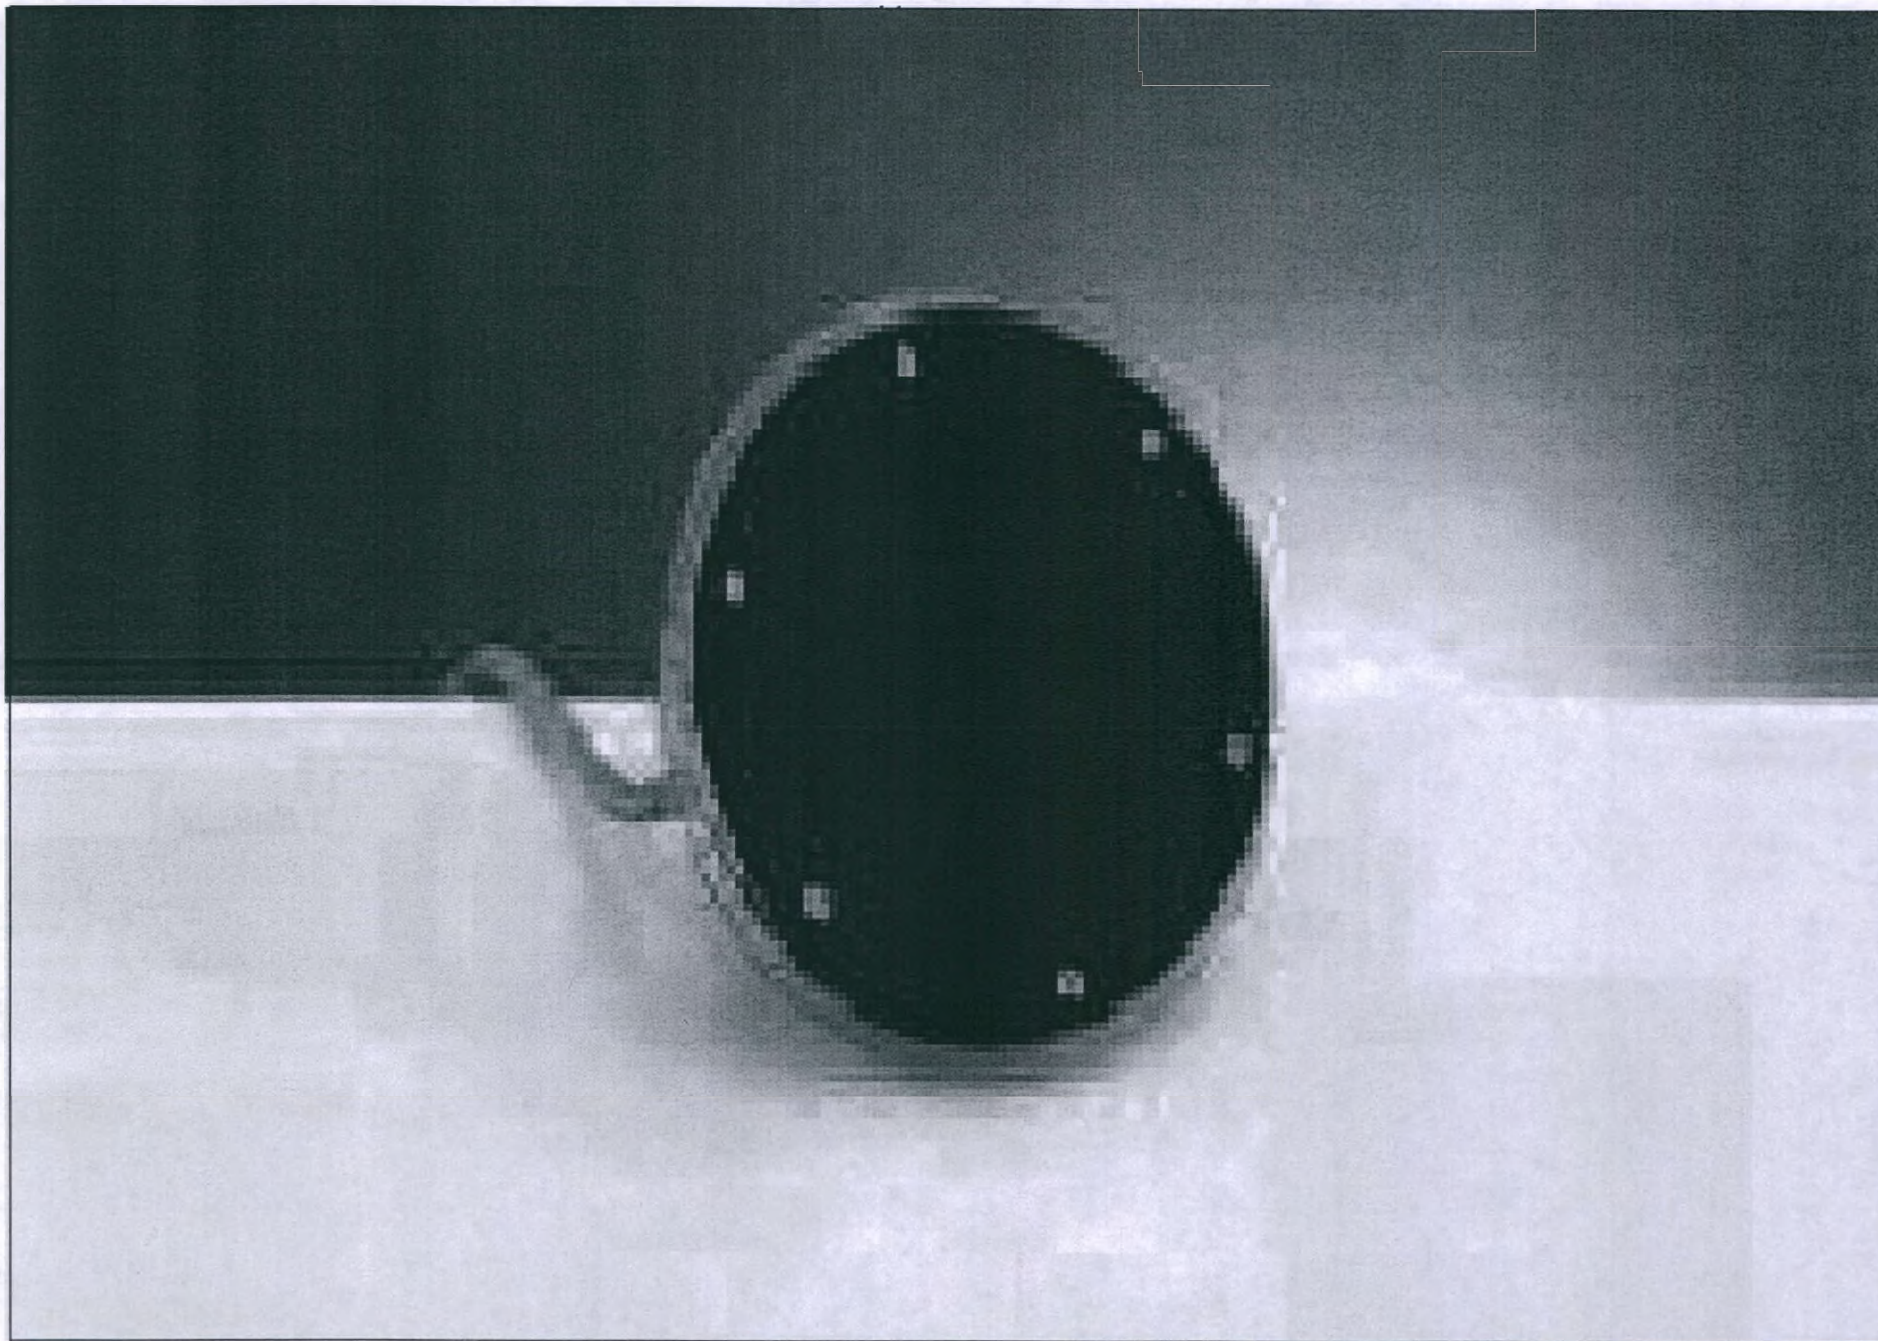


15.в. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДПК-1* или *ДПК-1М*.

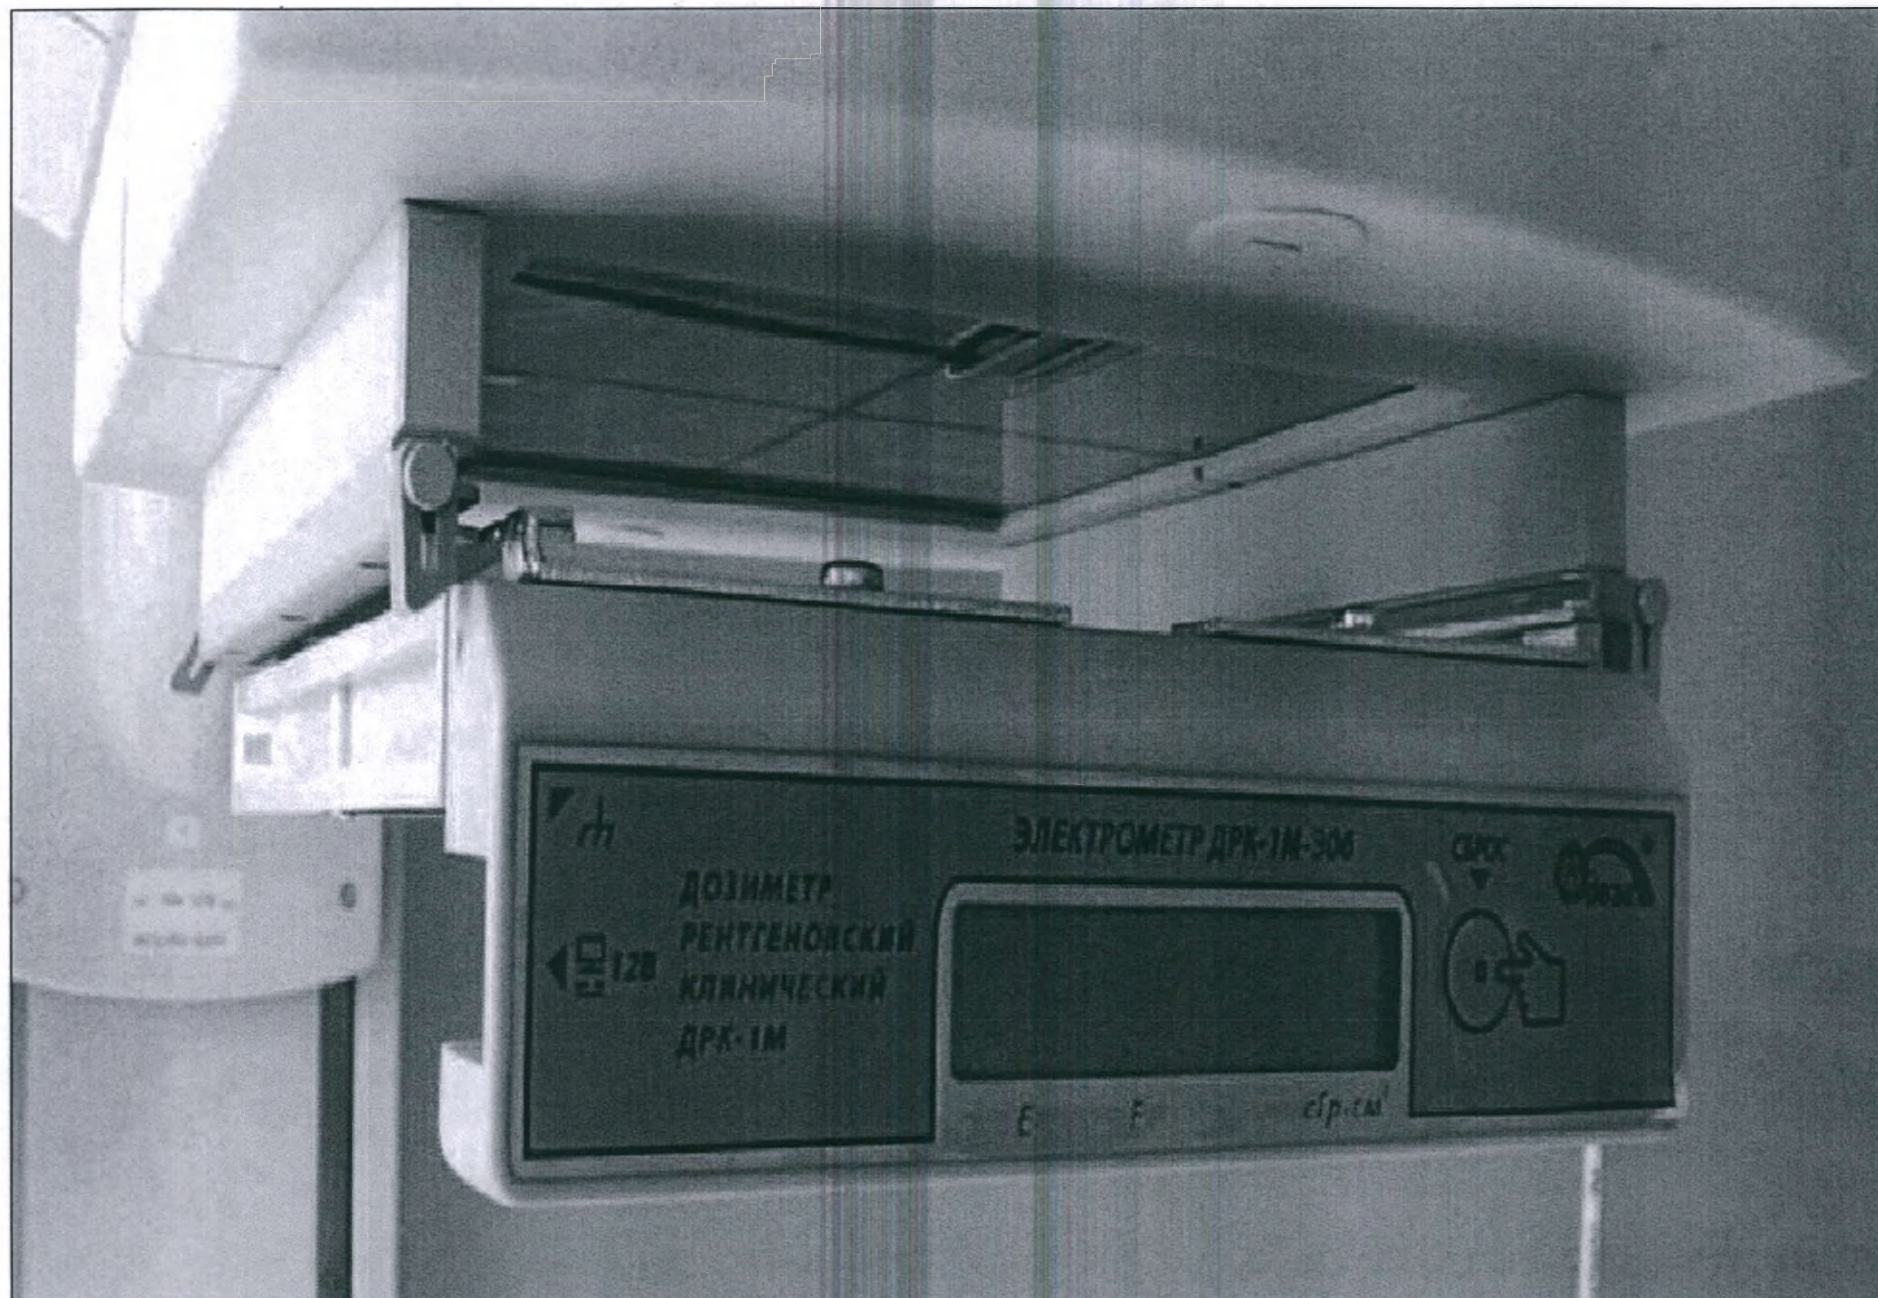


15.г. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

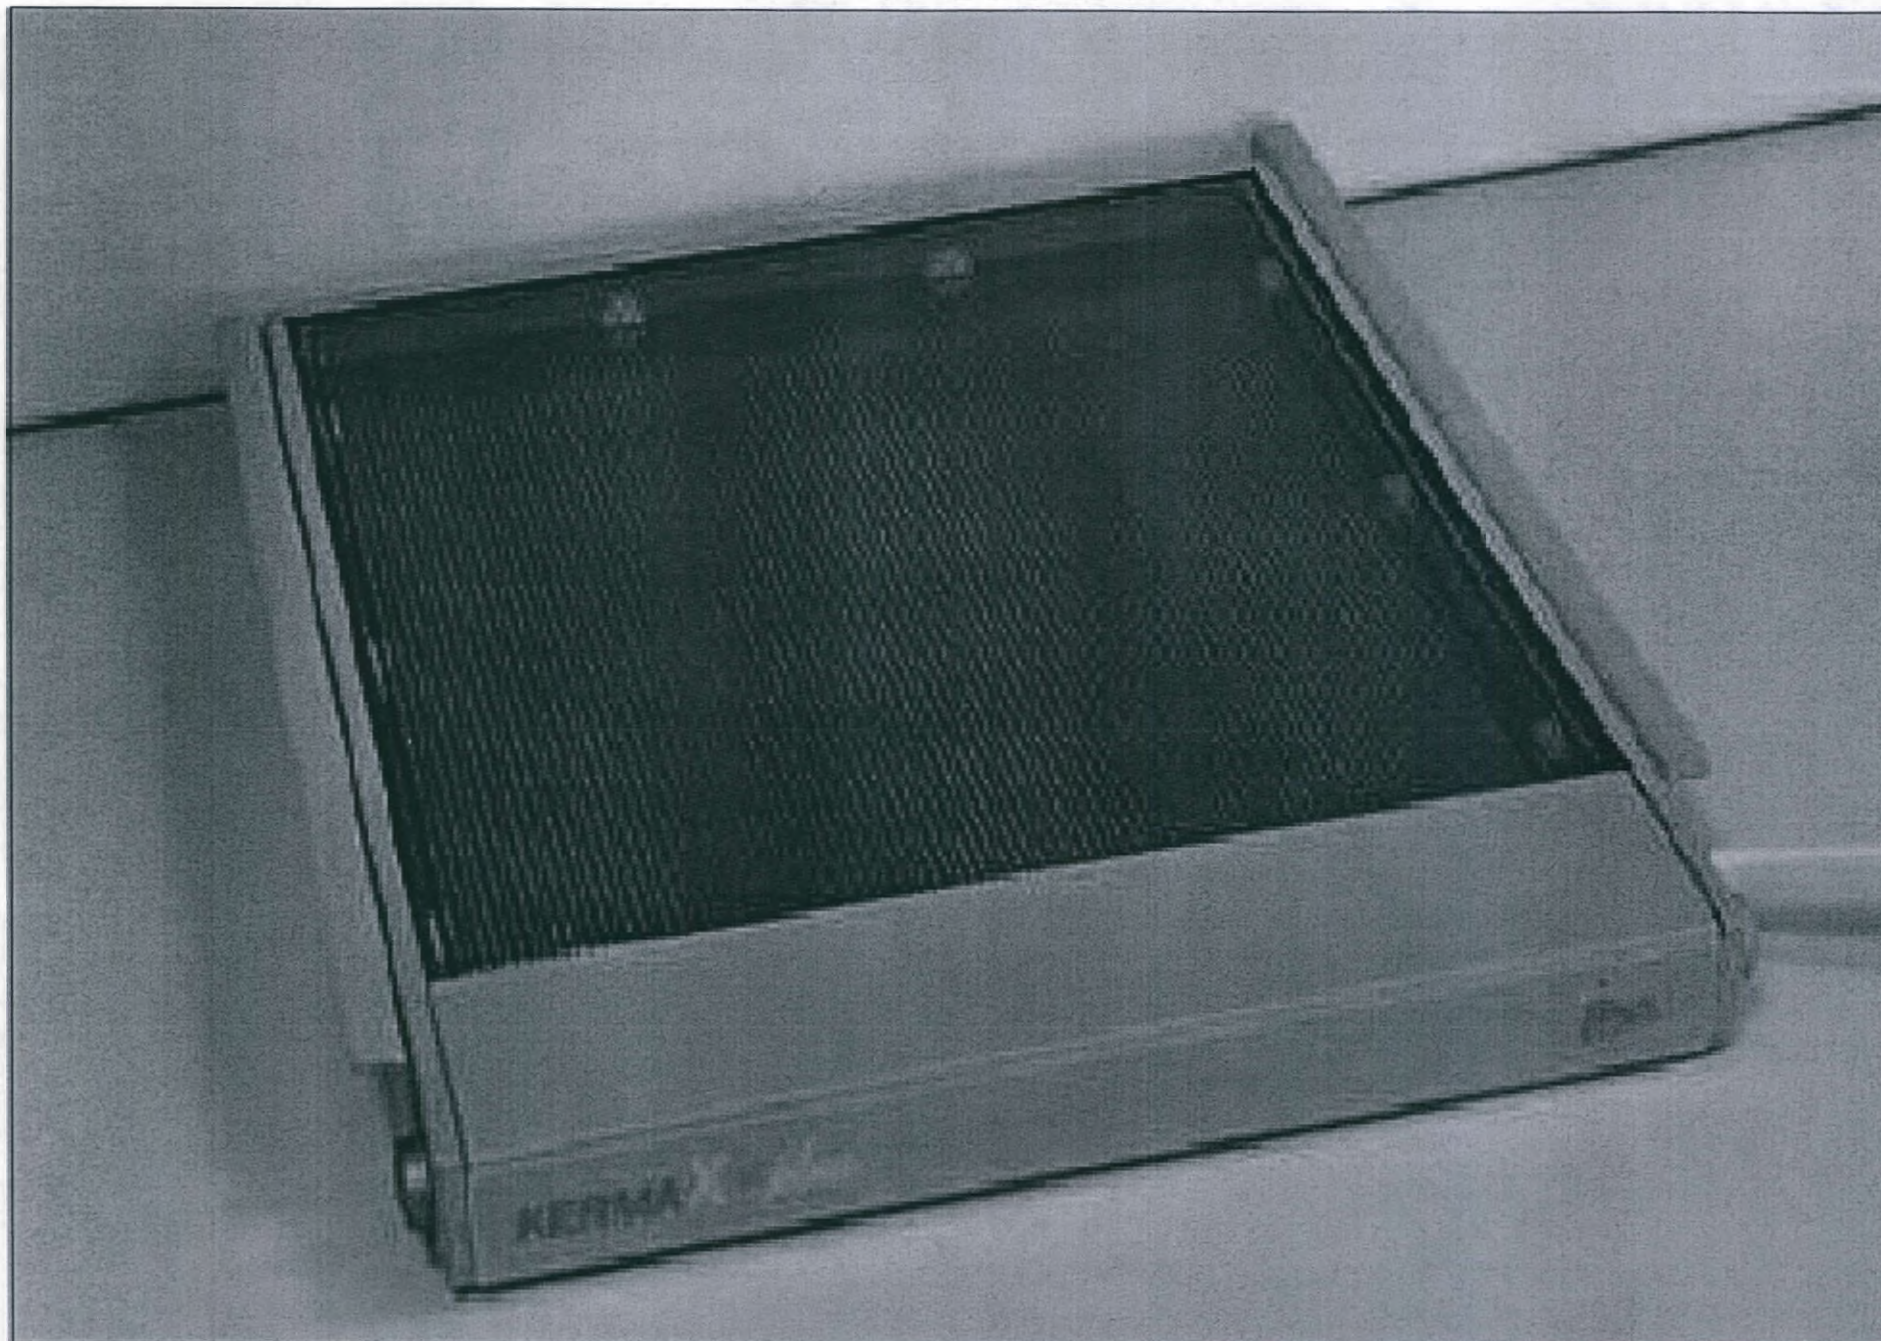


16. Измеритель производства дозы на площадь KermaX plus 120-132.

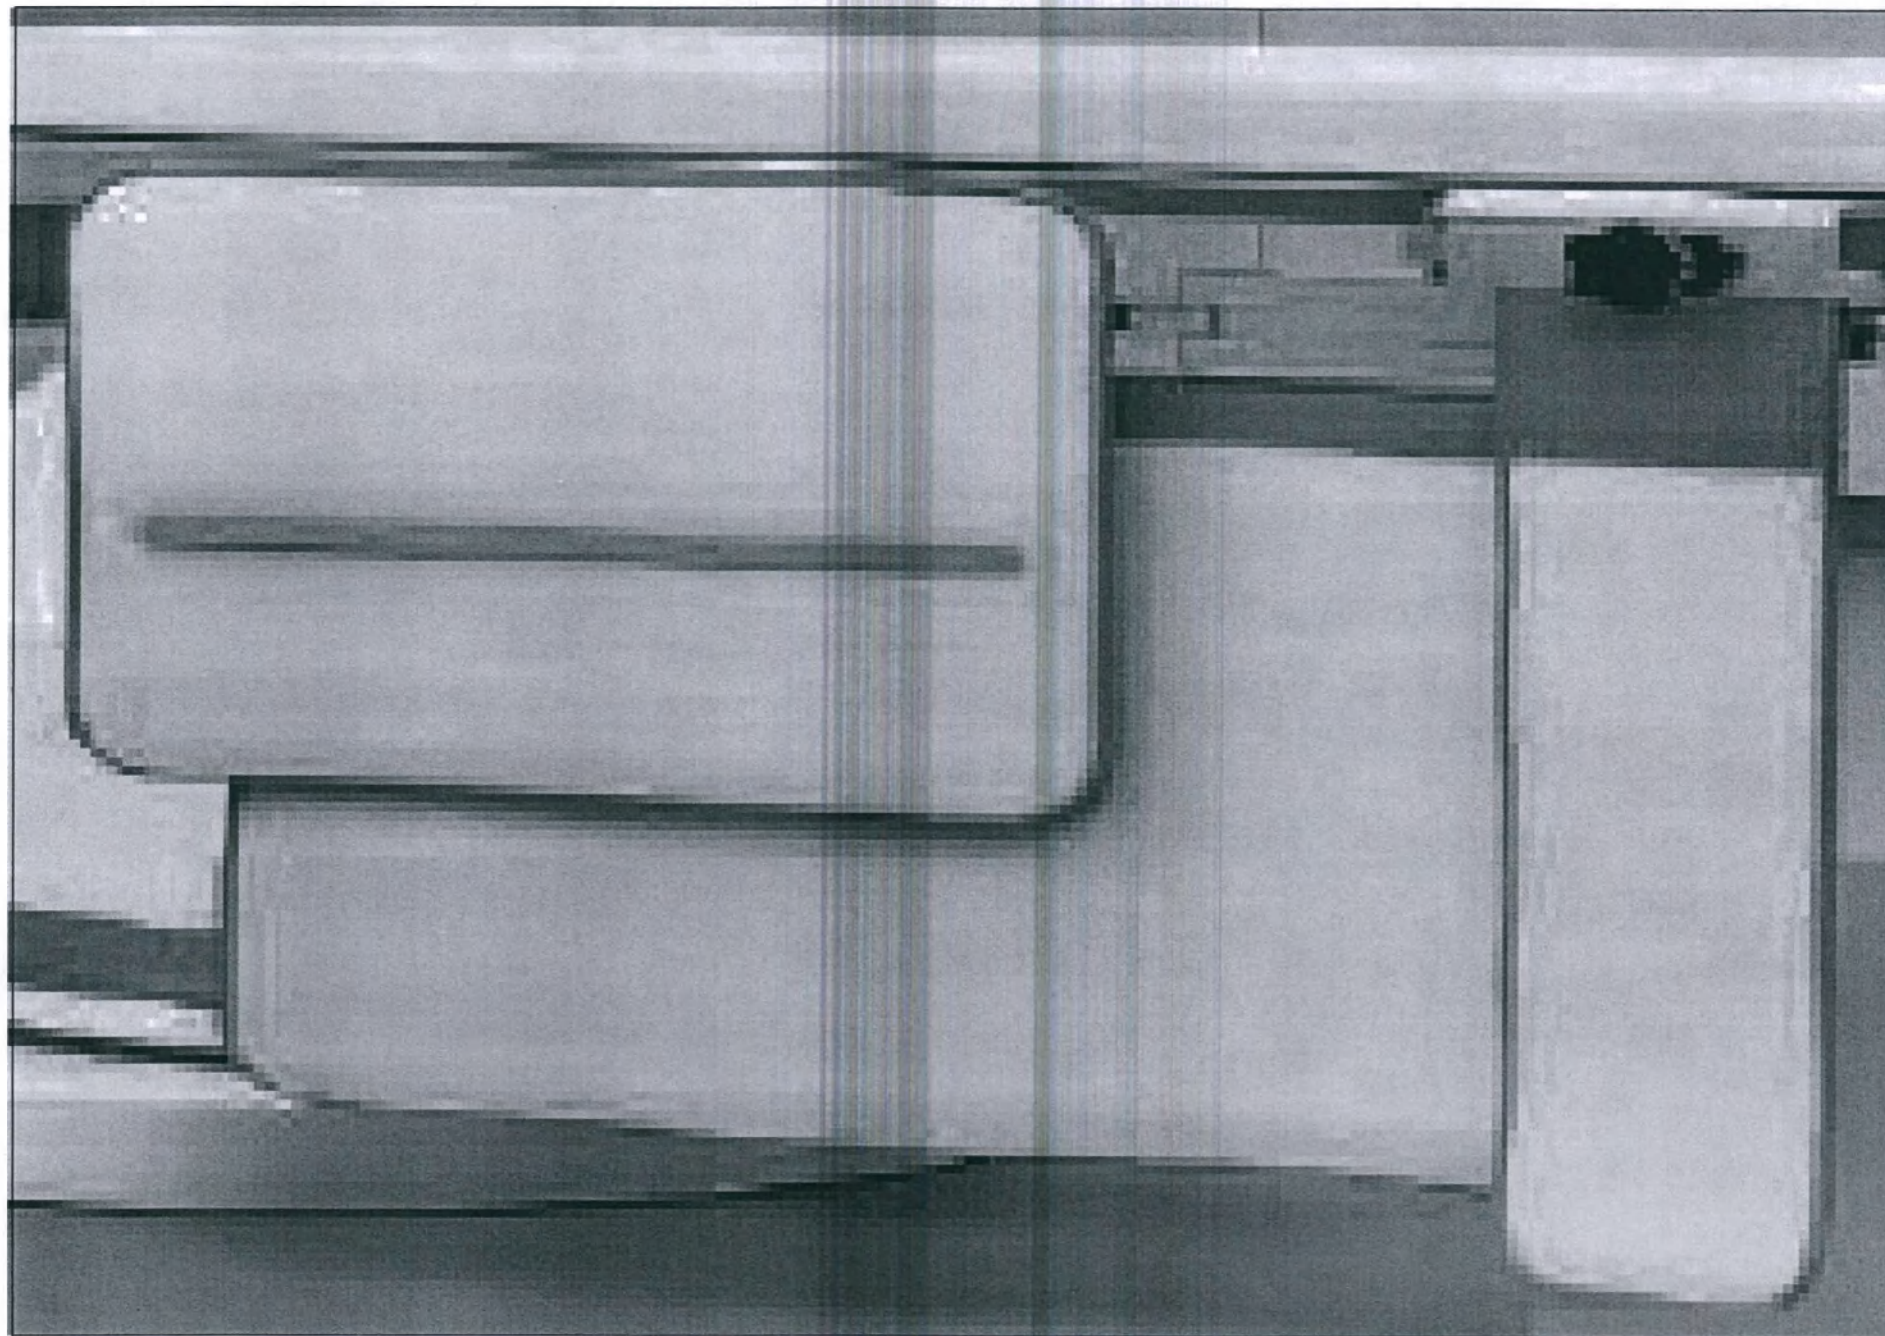


17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

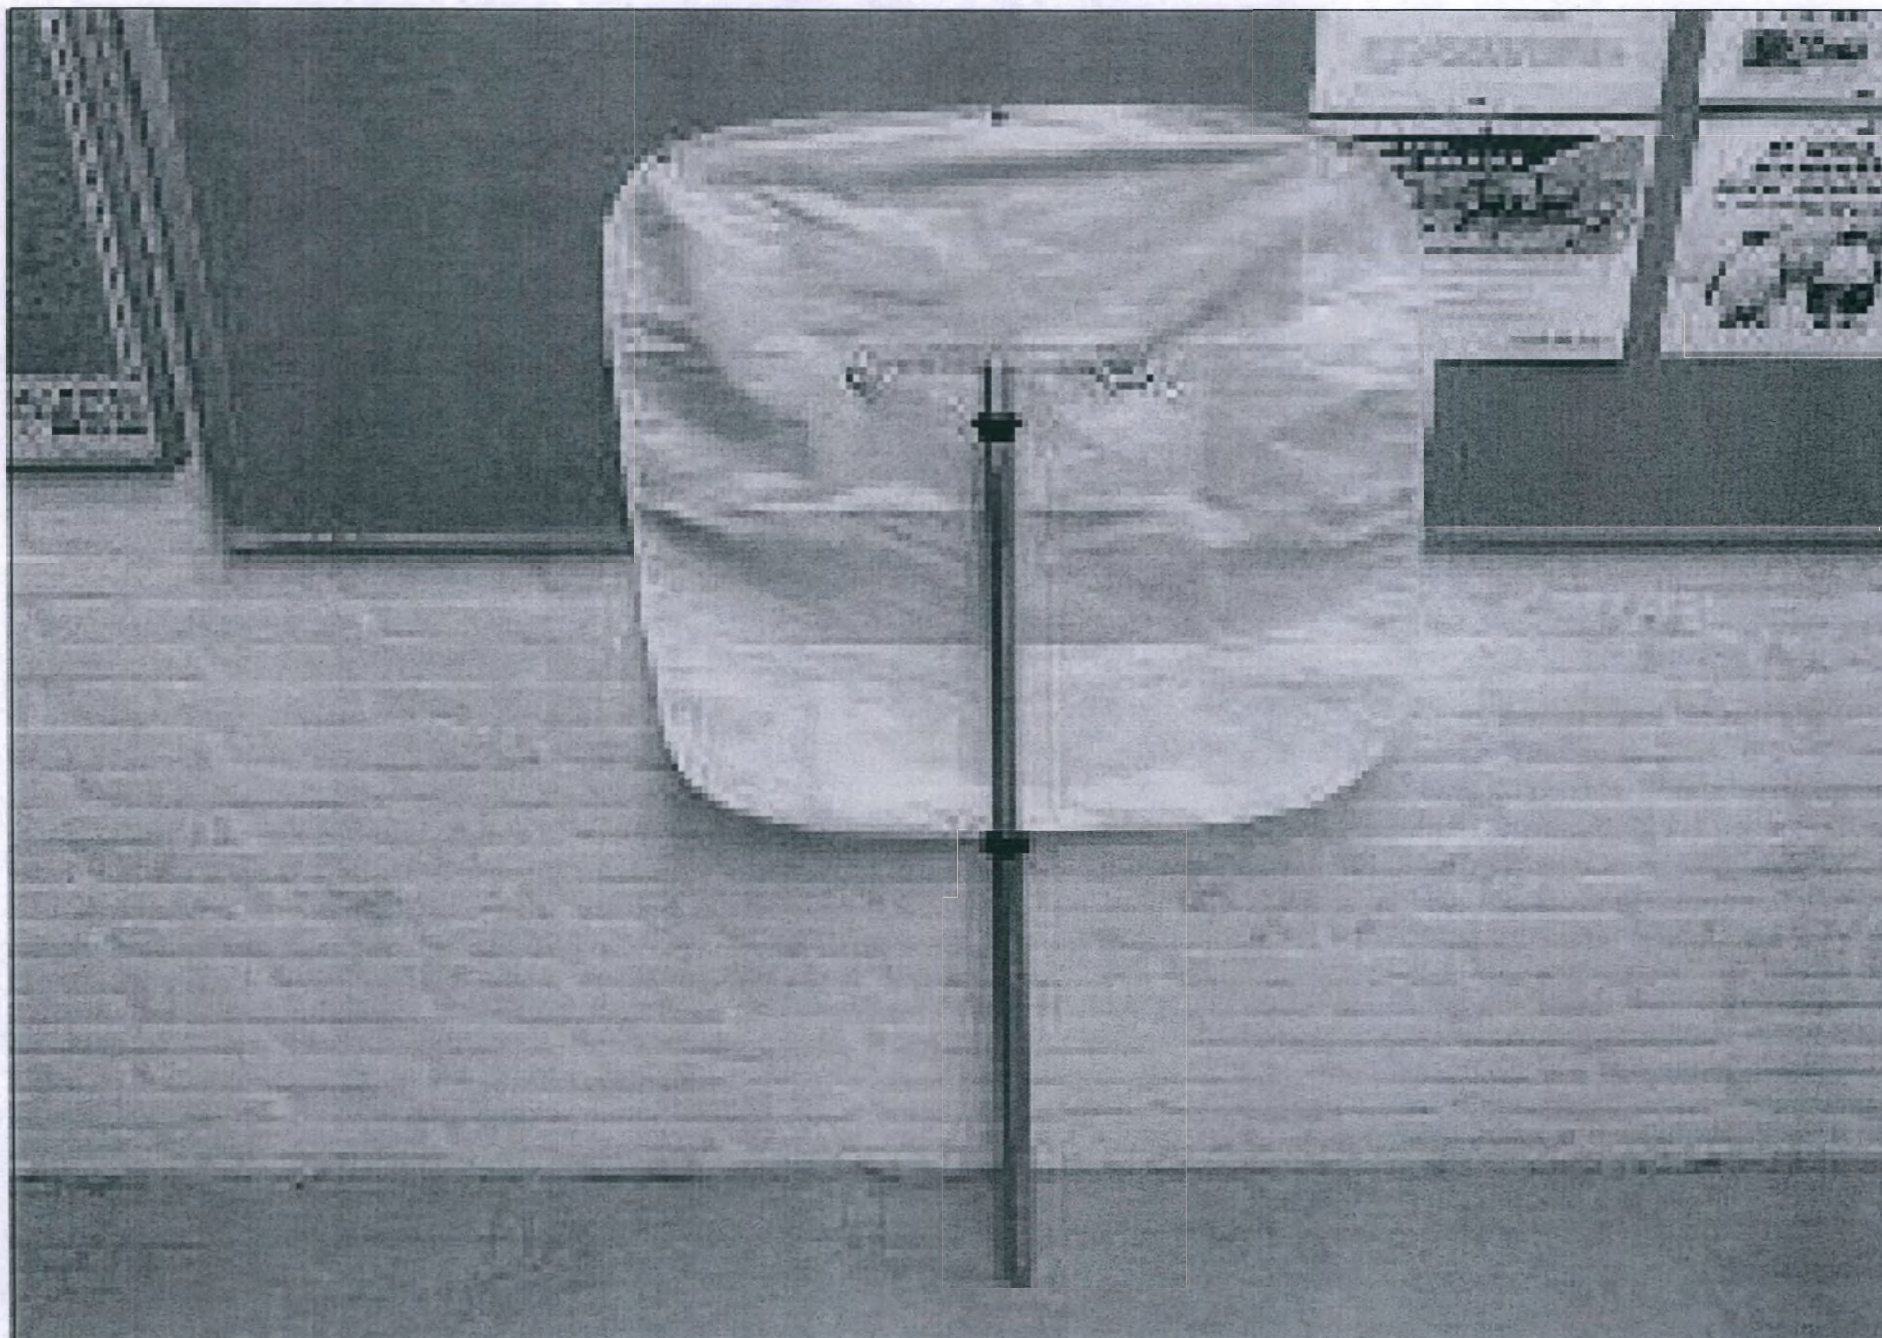


18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

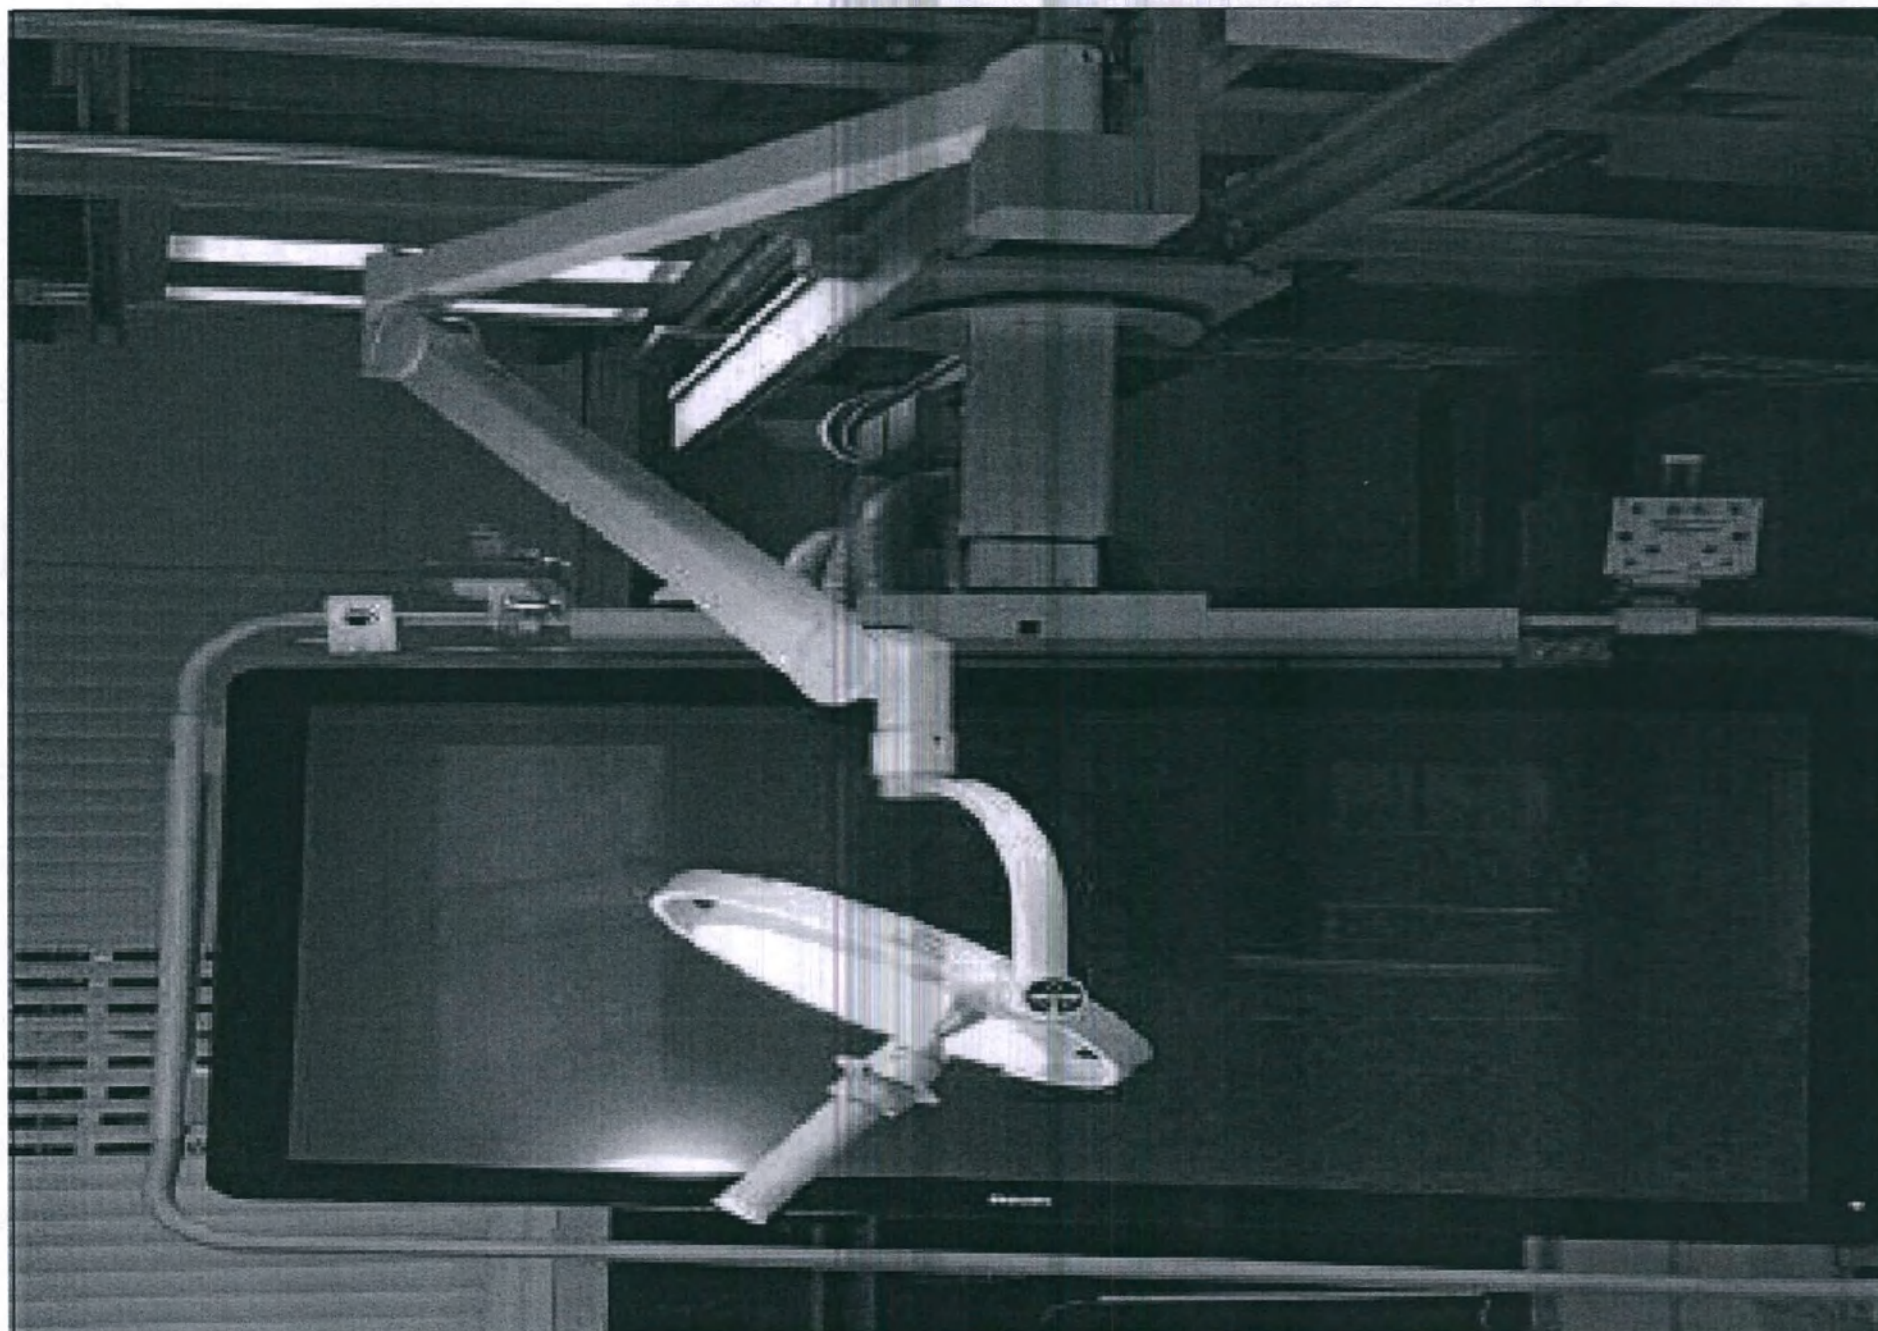

19. Лампа для осмотра

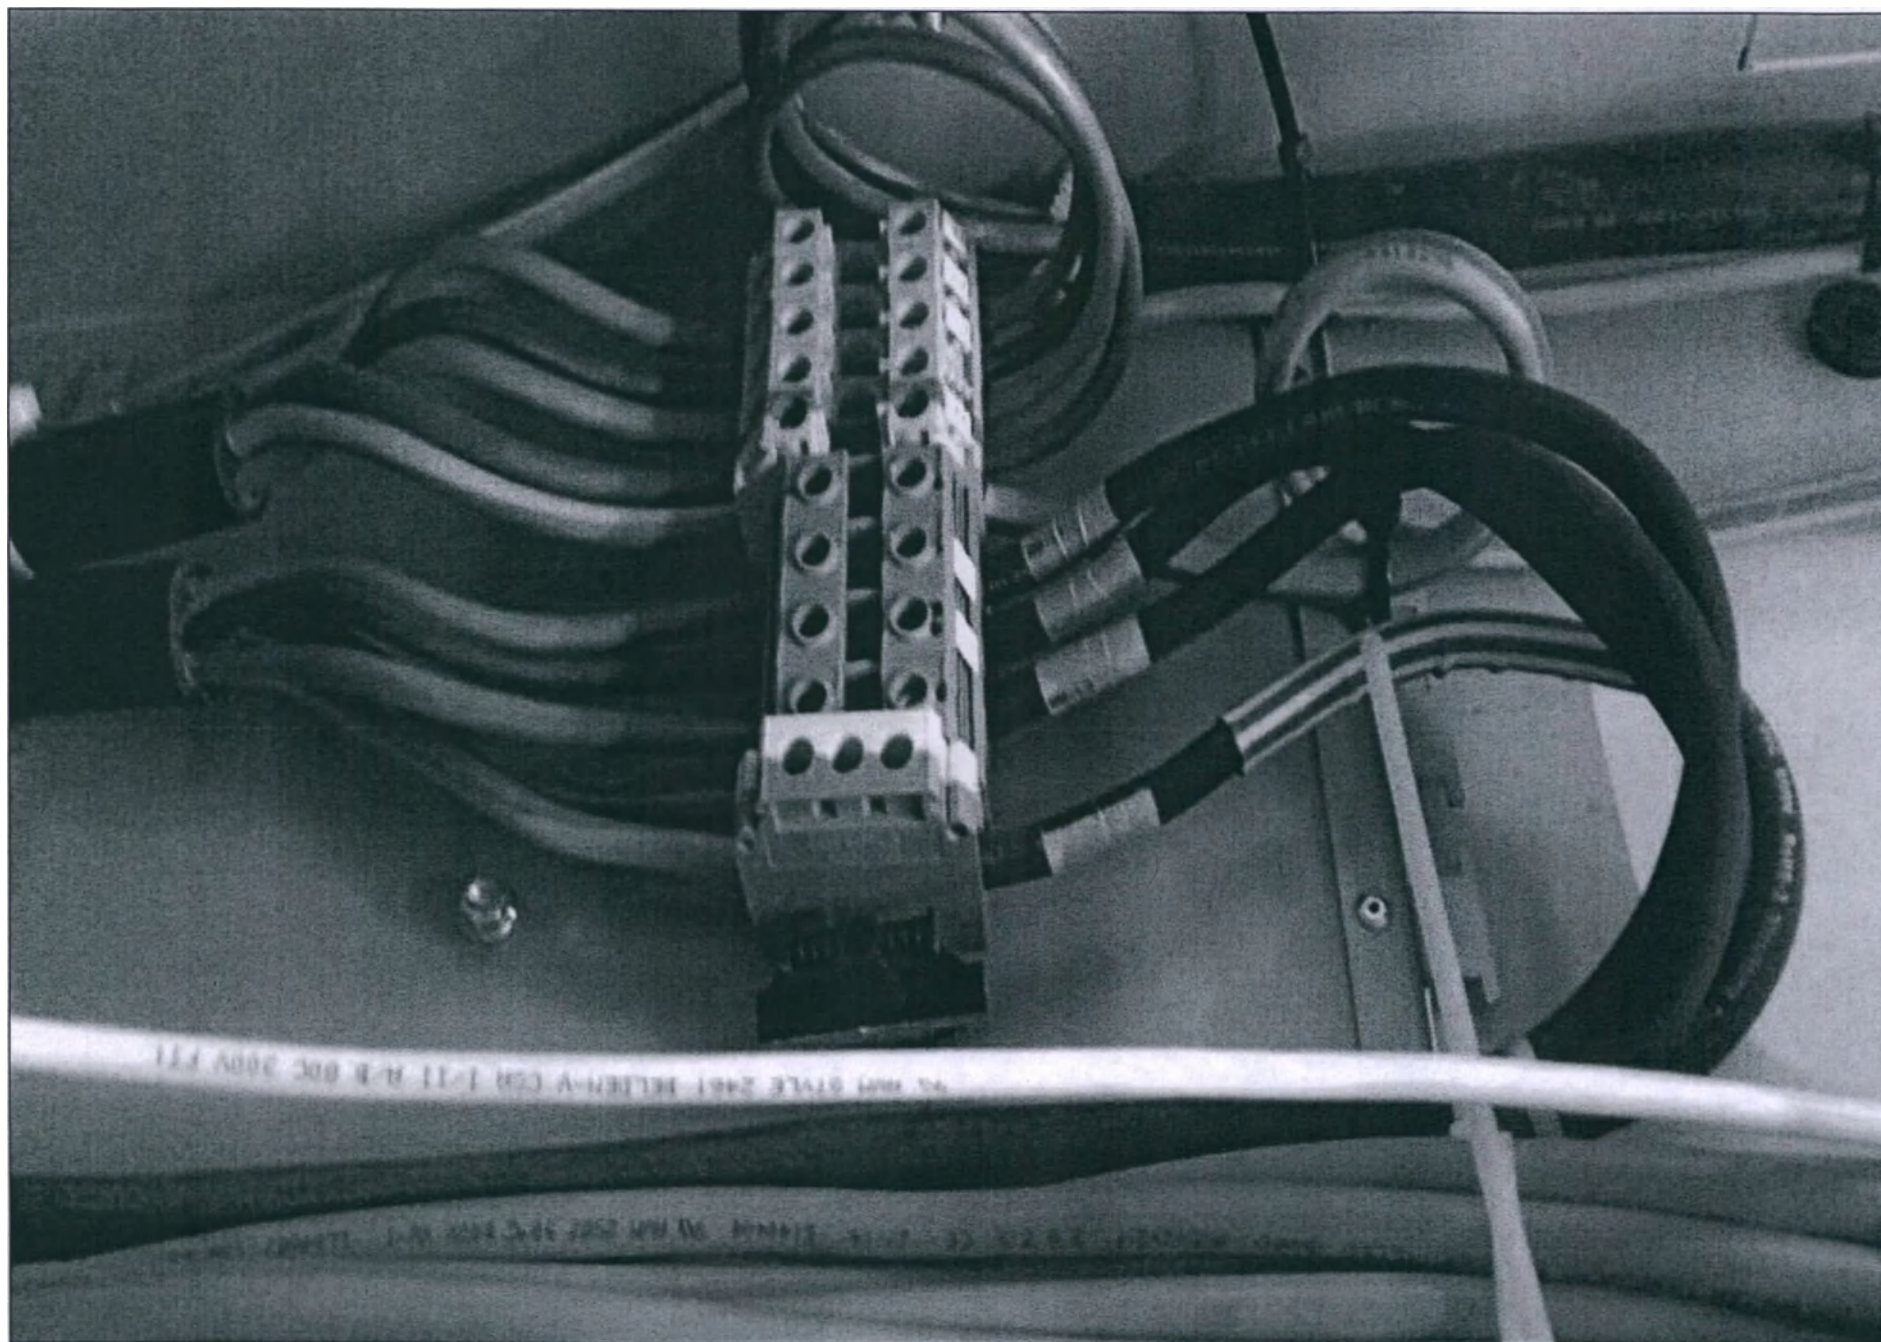

20. Кабели питания, 10 шт.

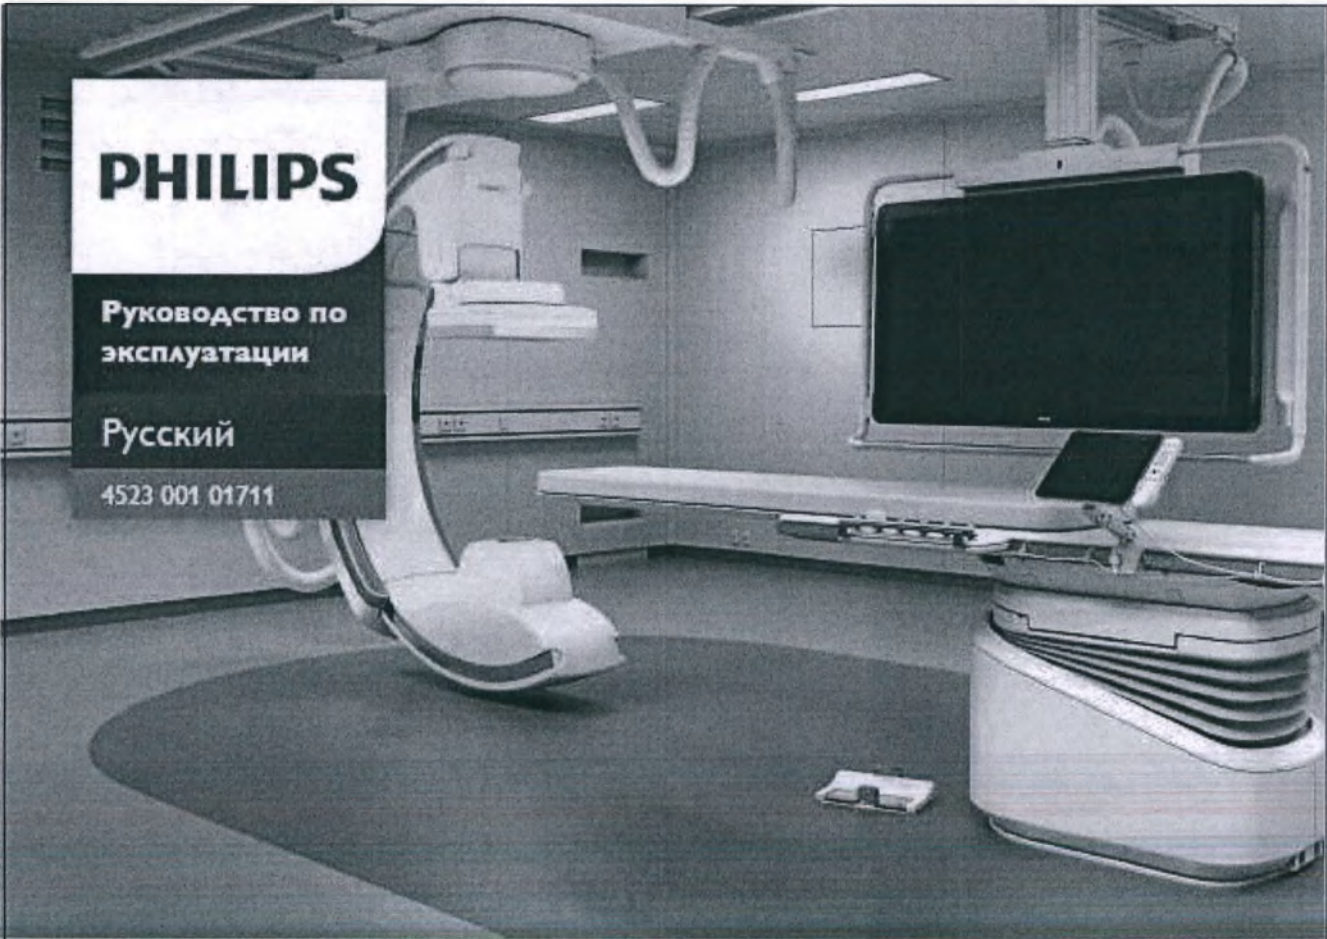

PHILIPS

**Руководство по
эксплуатации**

Русский


4523 001 01711

Philips Azurion


Версия 2.2

21.в. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 7 M12 (вариант 2):

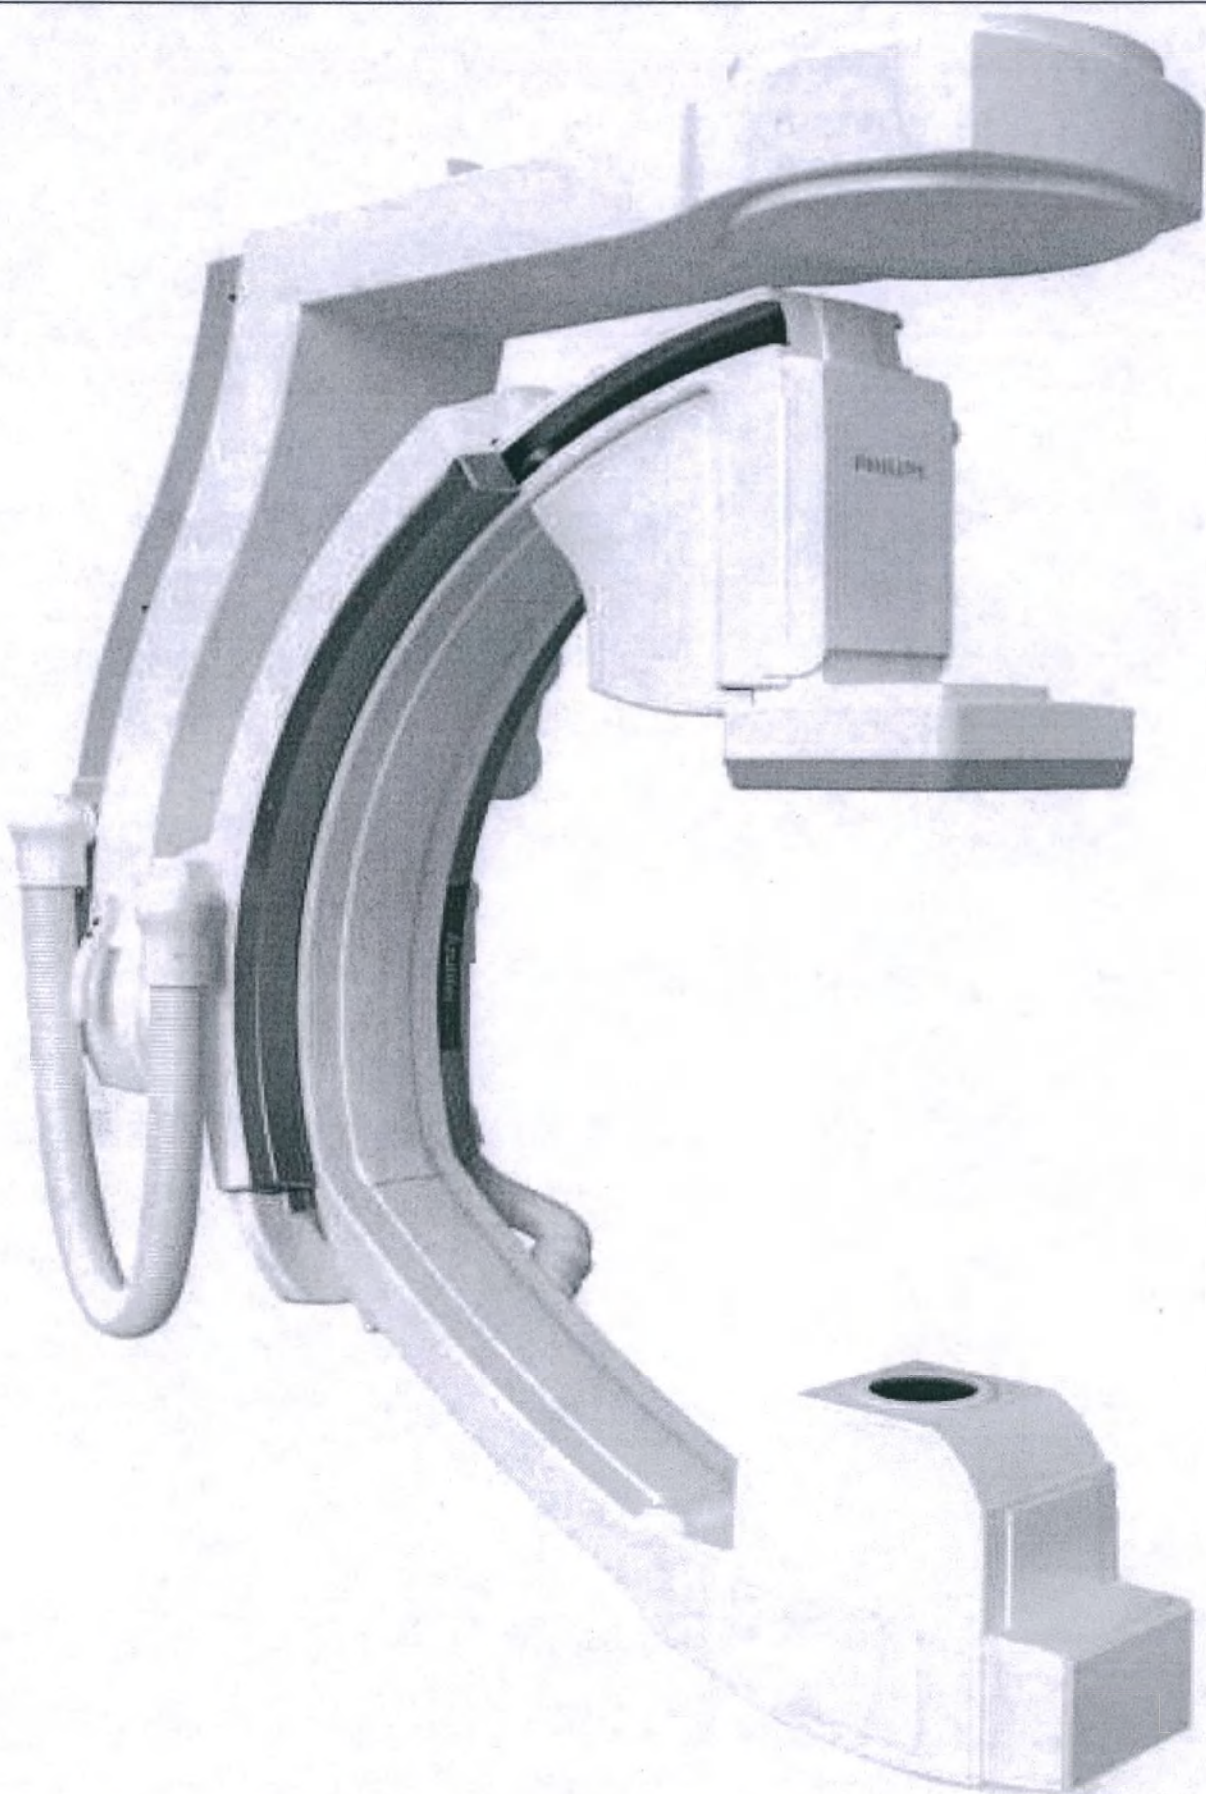


1. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.

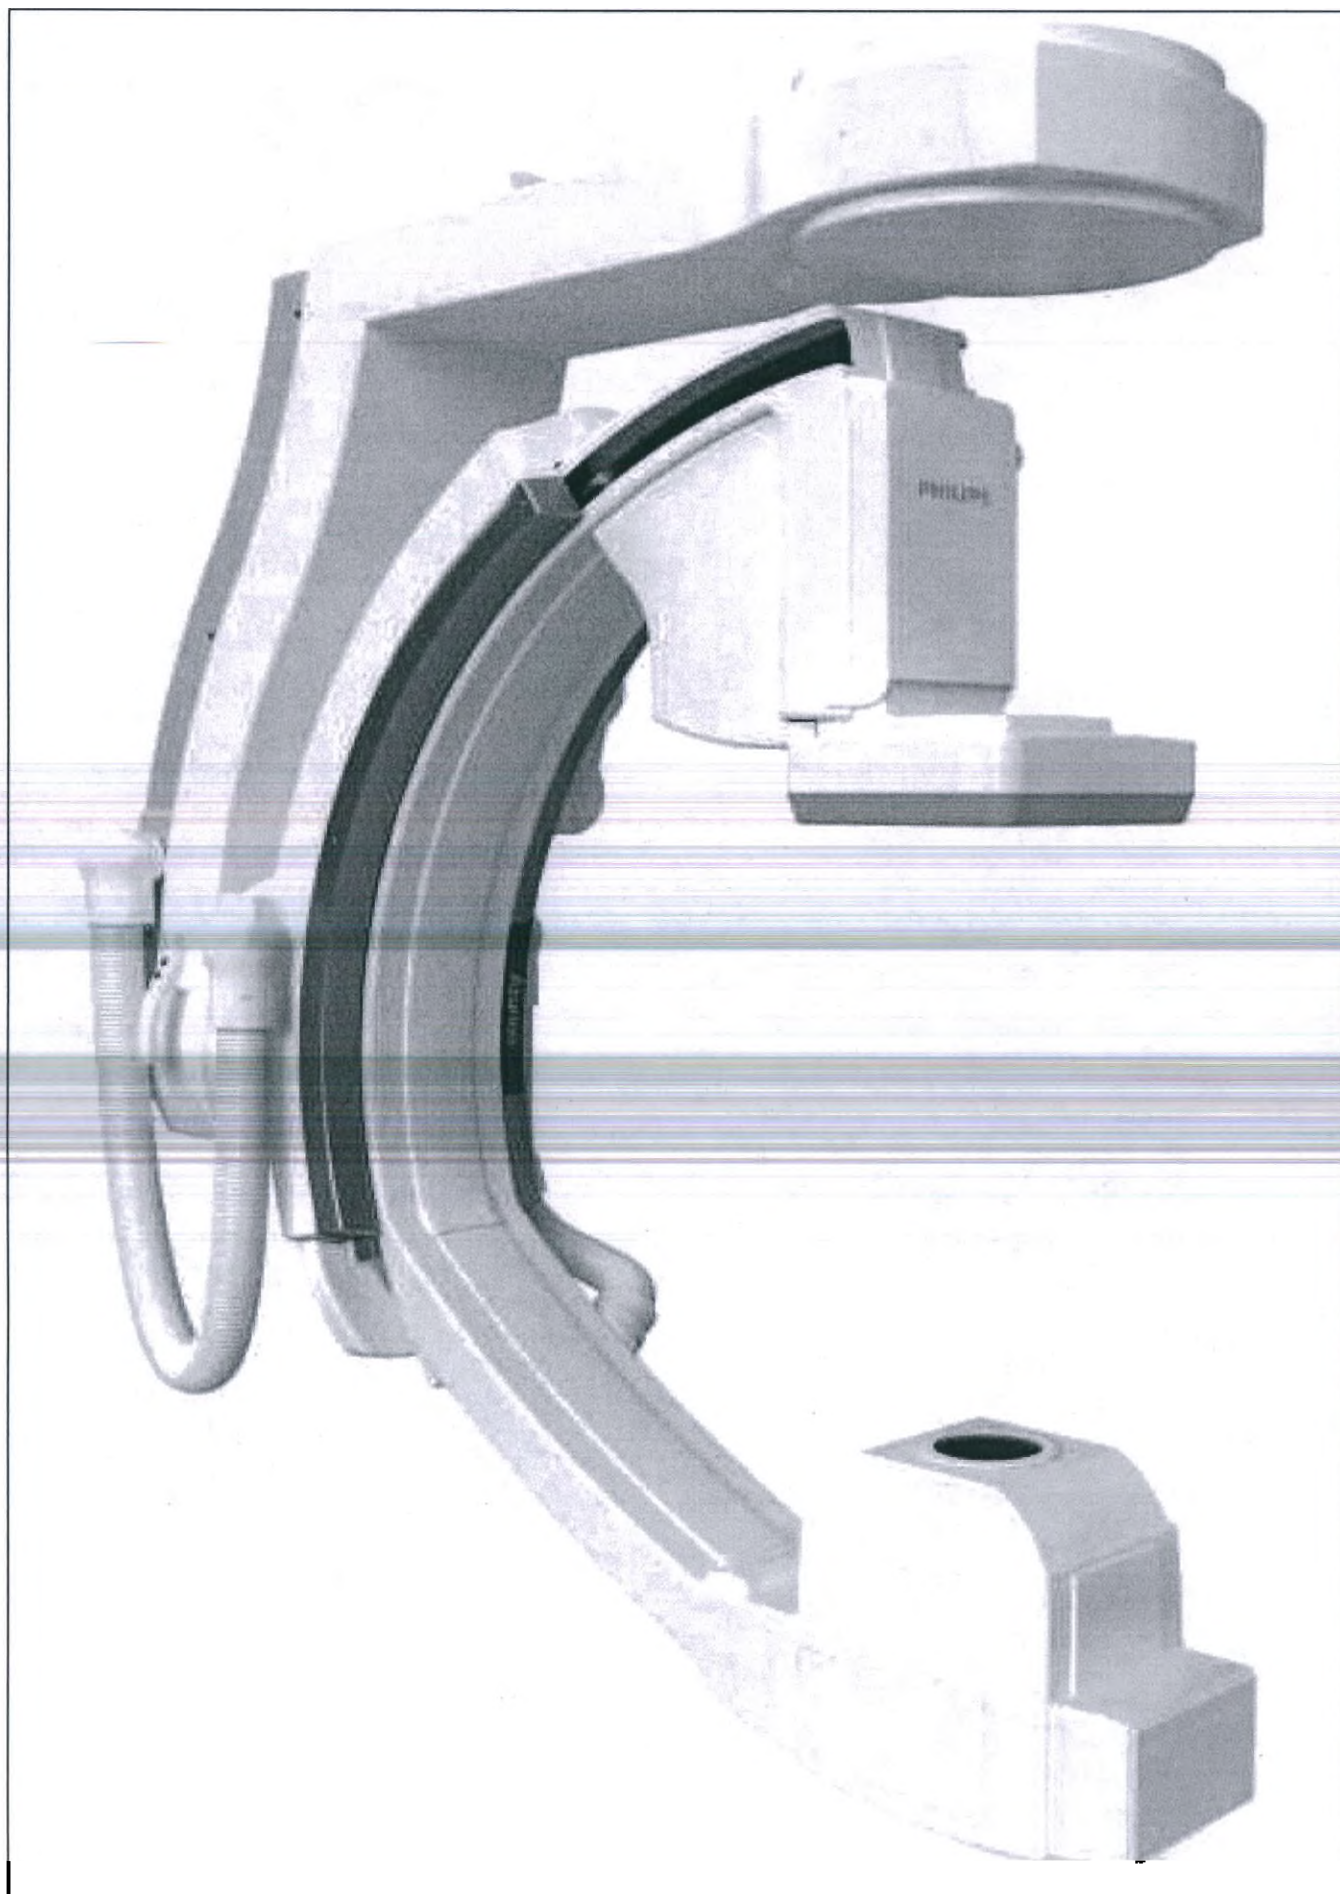


1.а. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

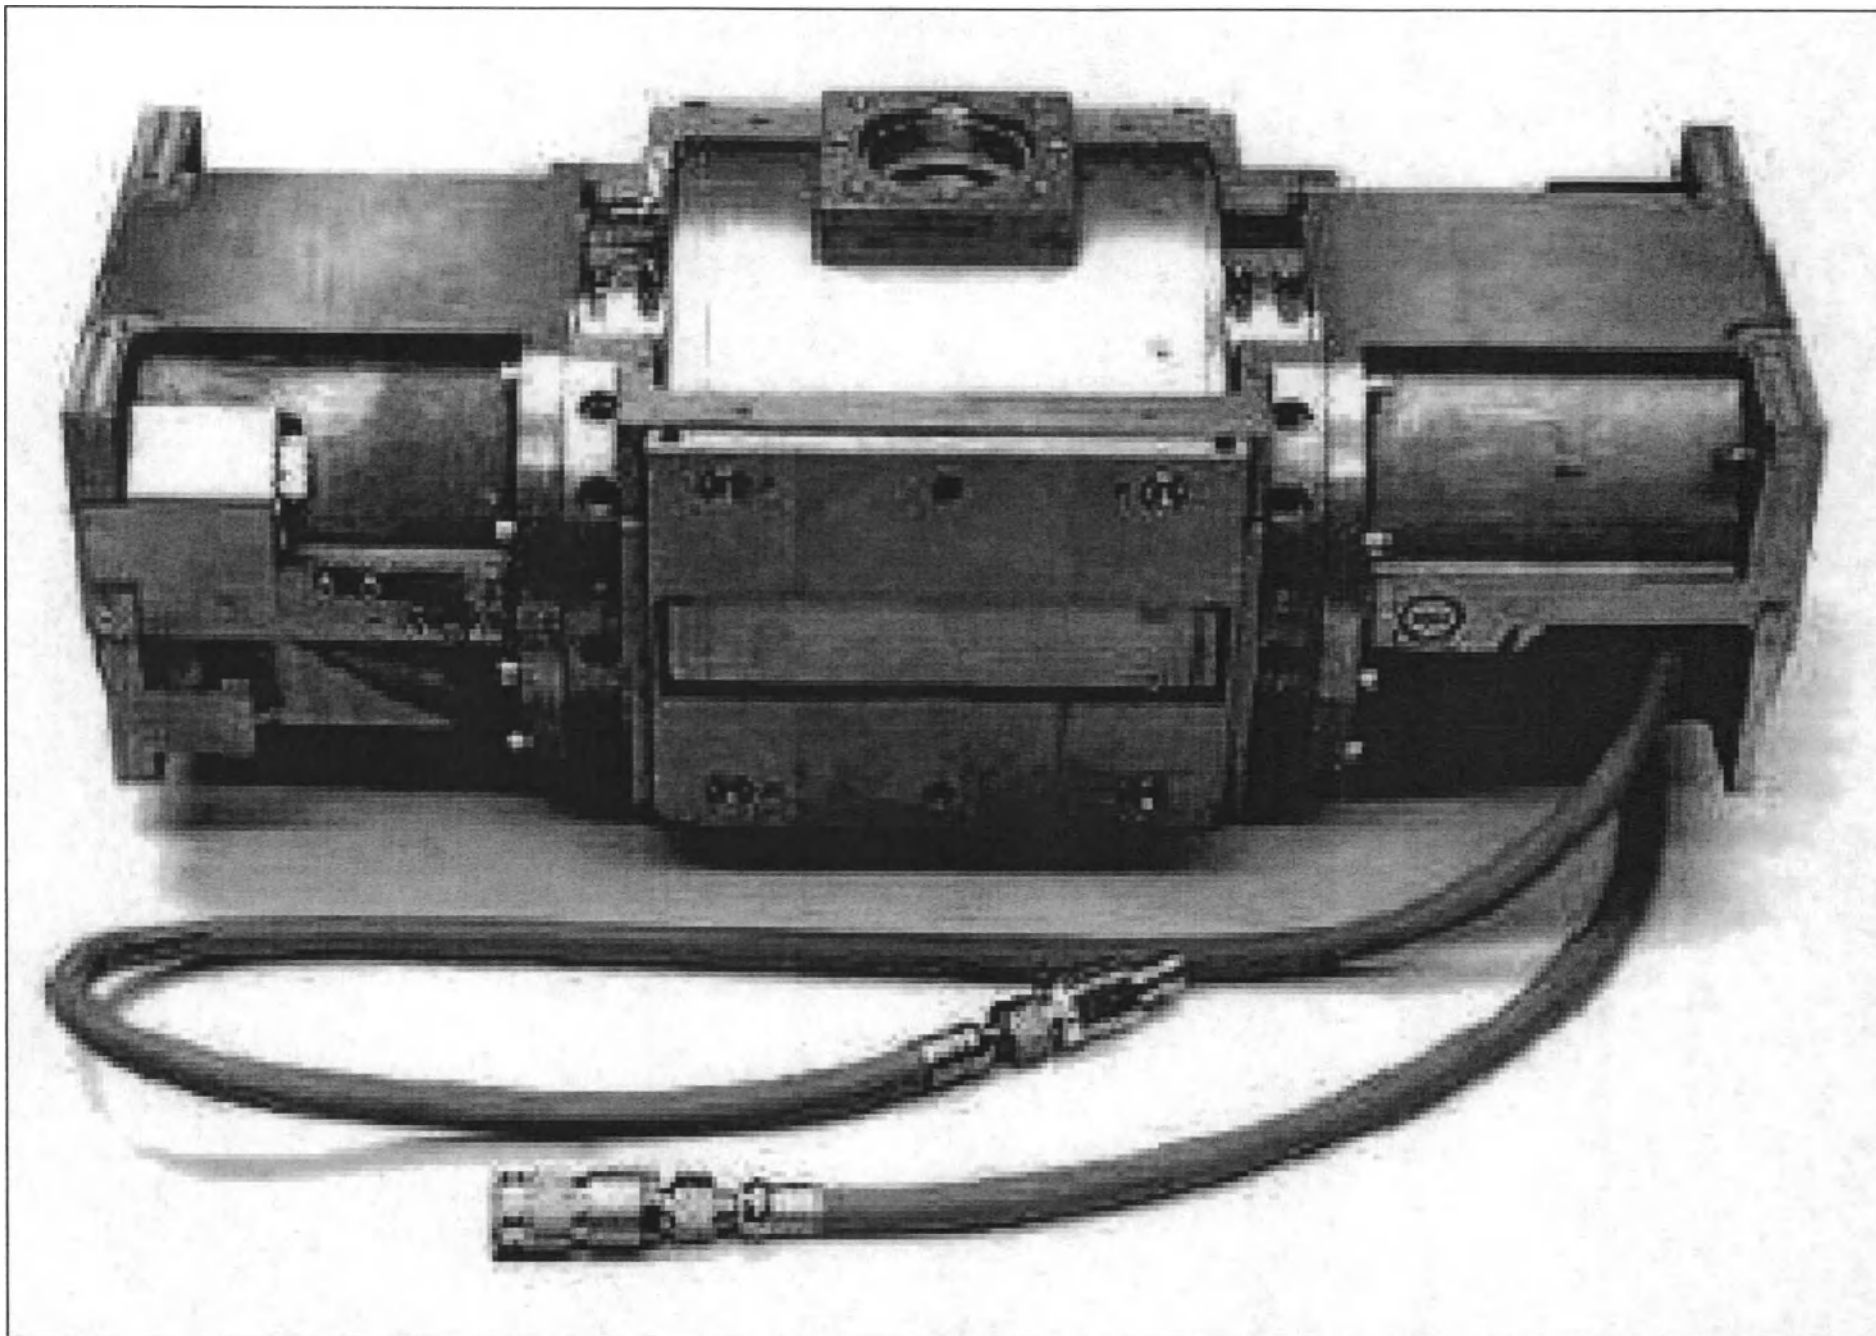


1.6. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

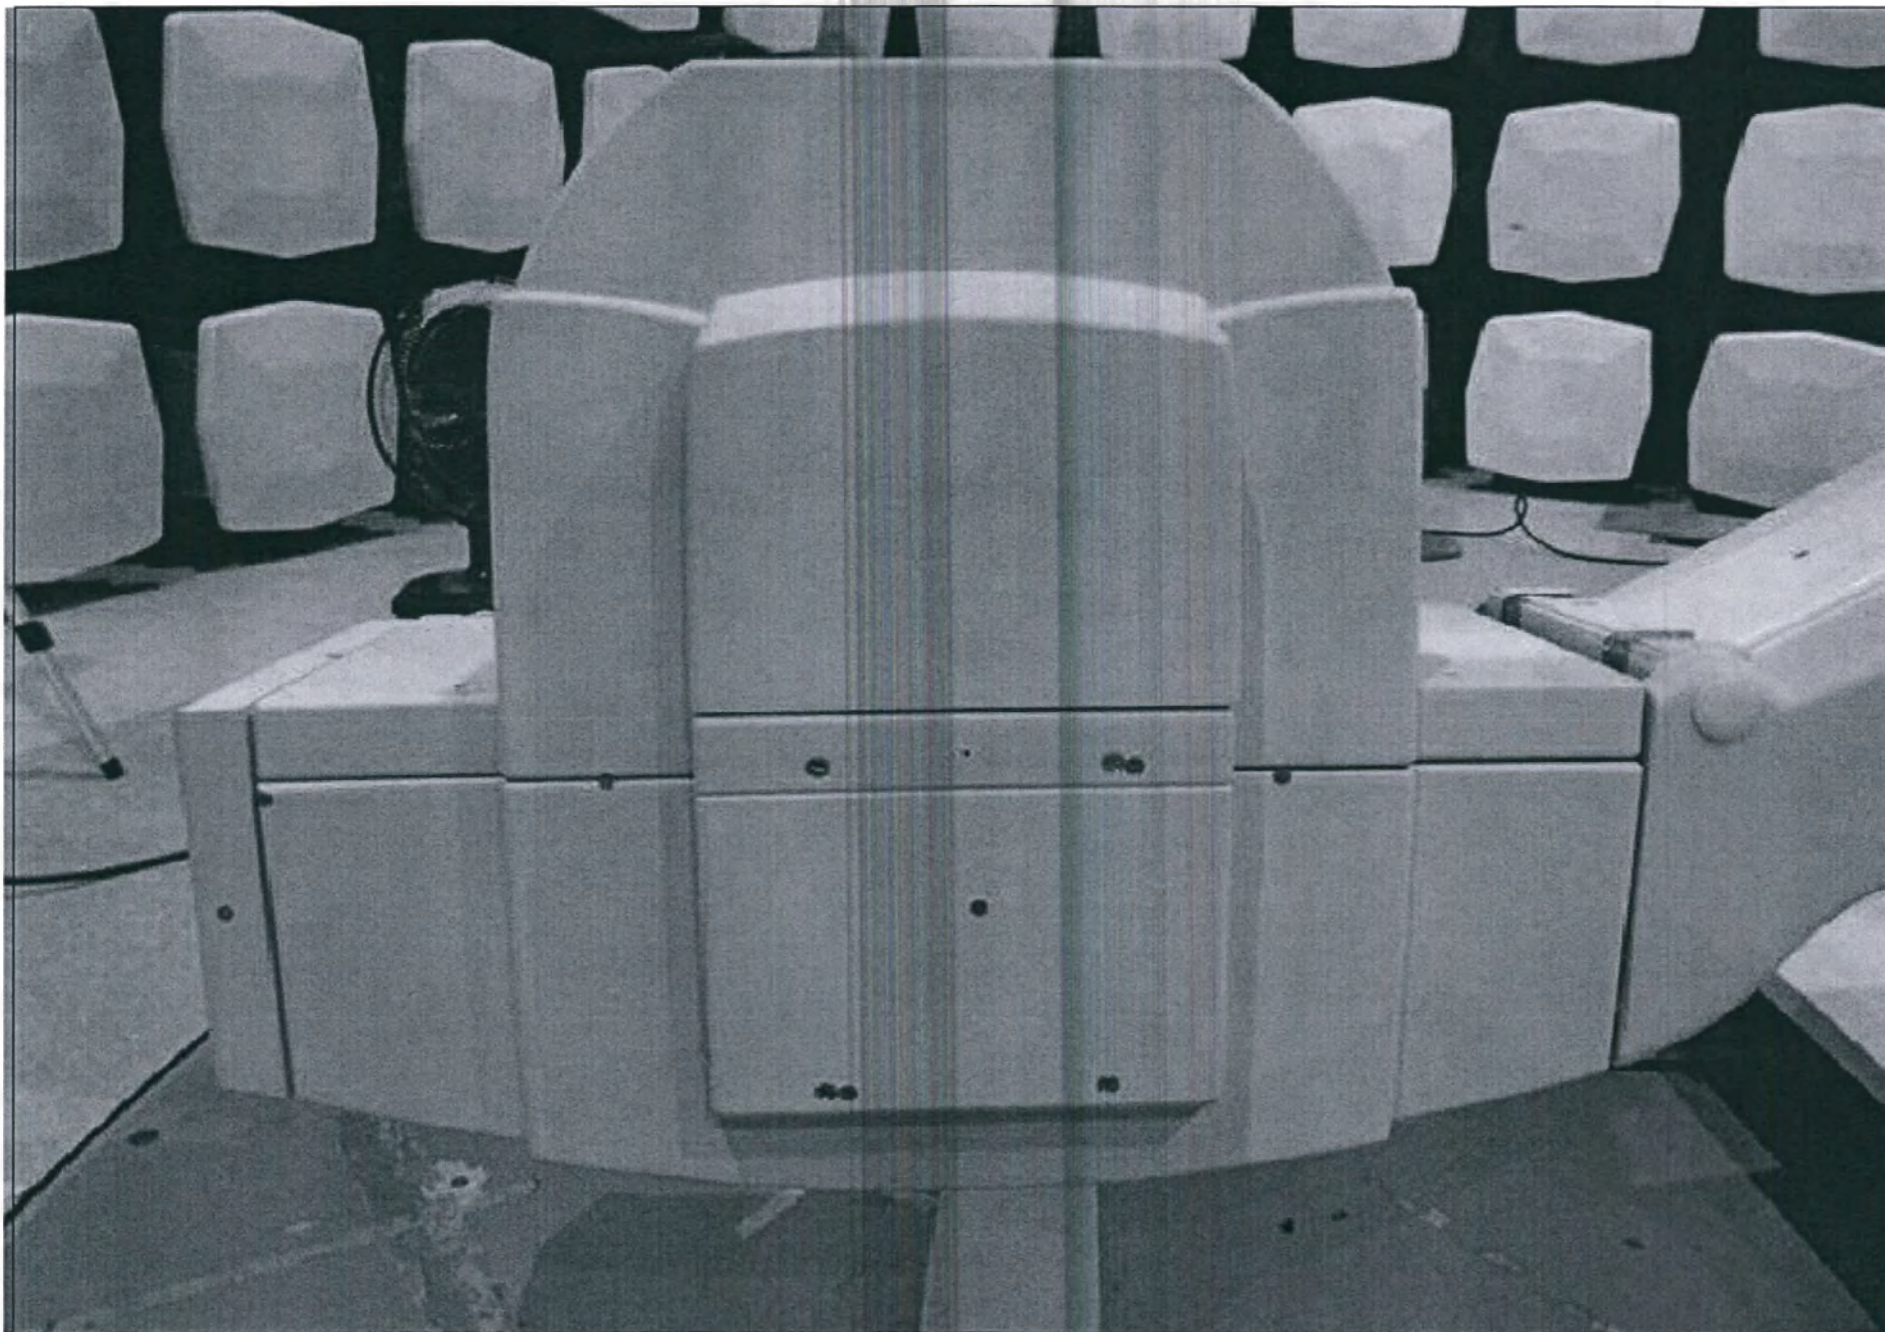


1.в. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

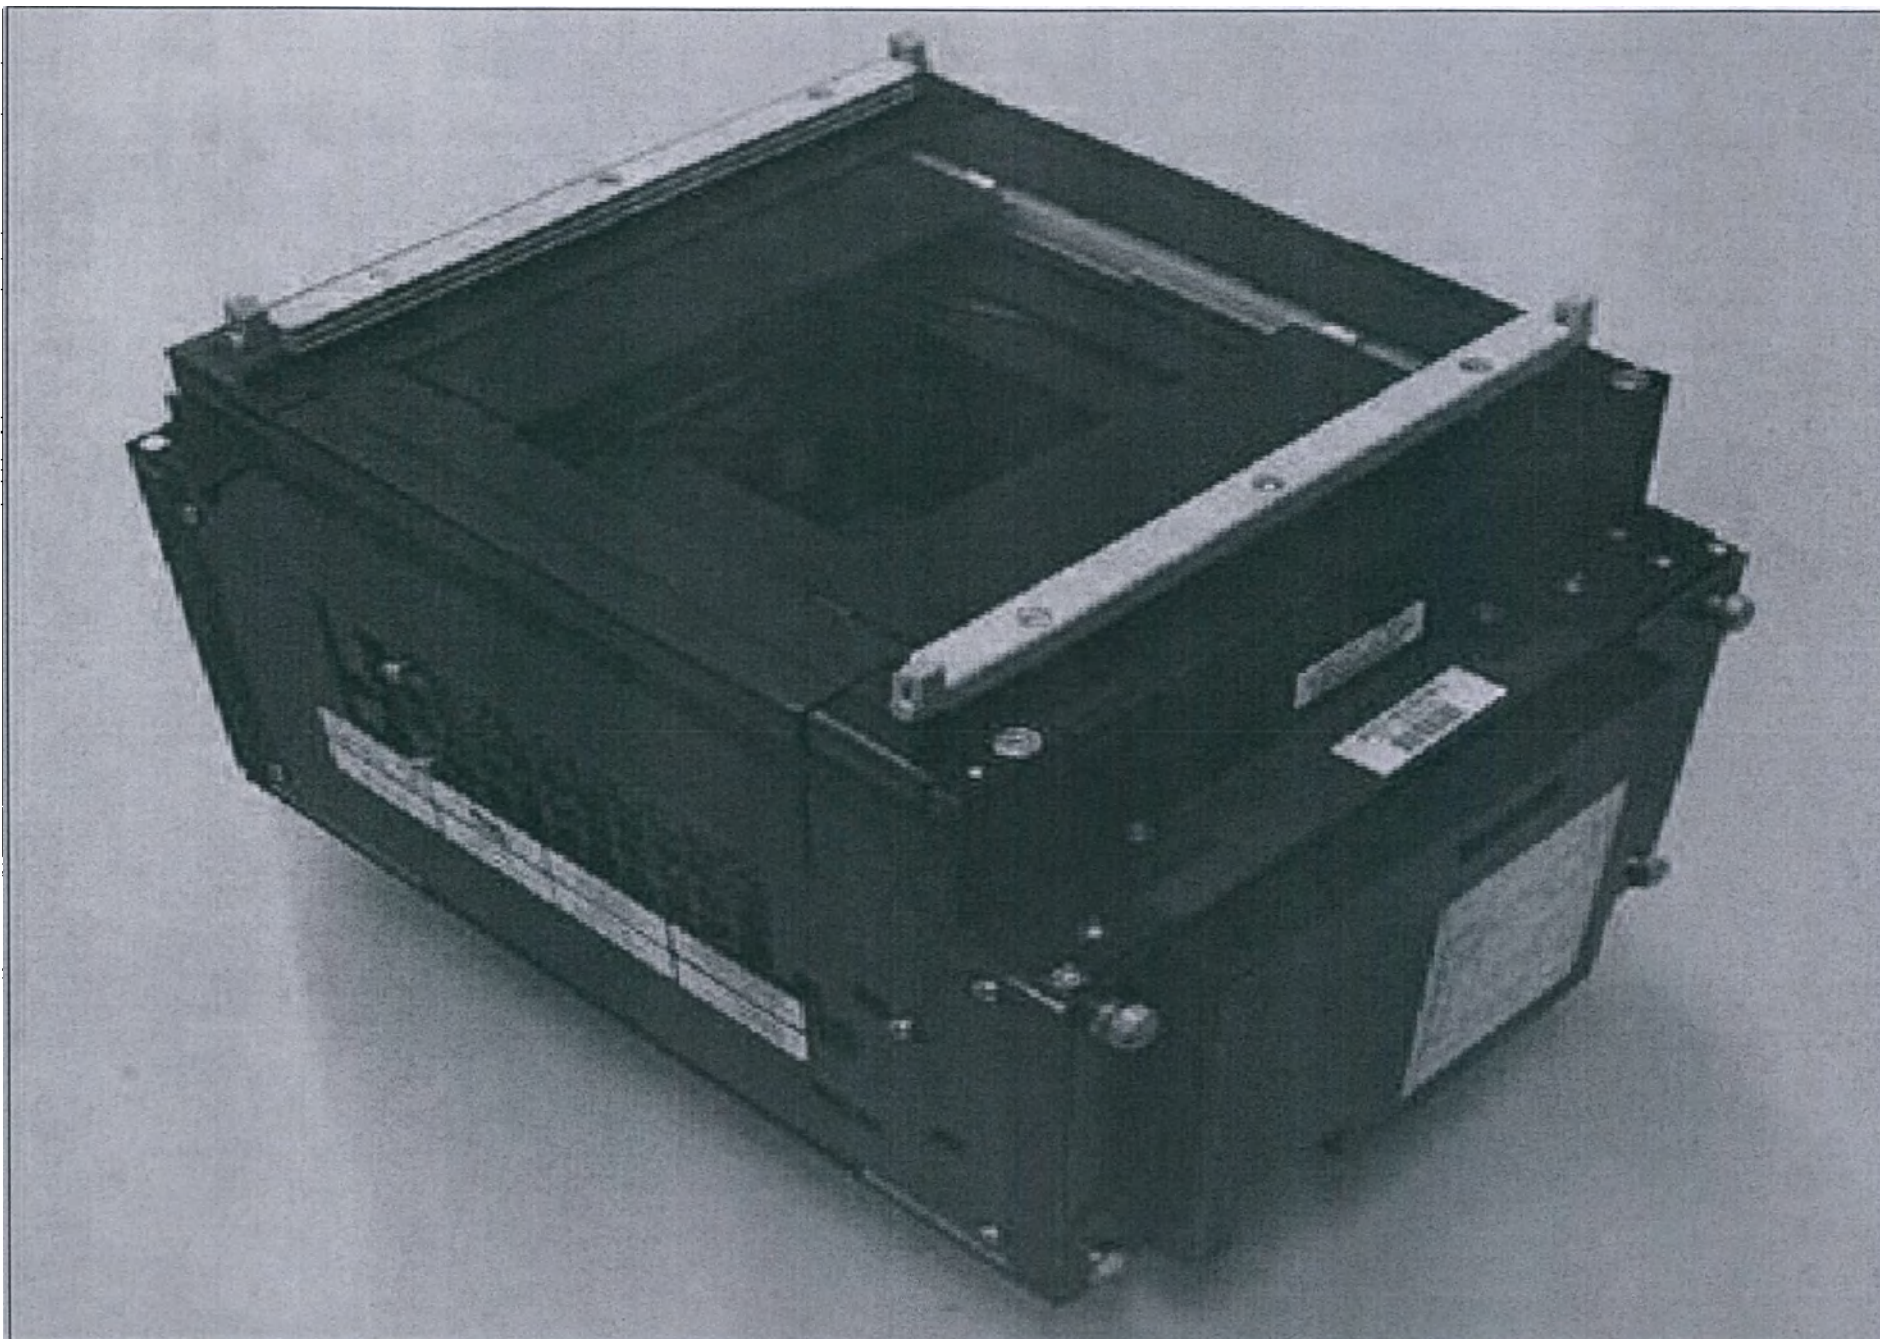


1.2. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

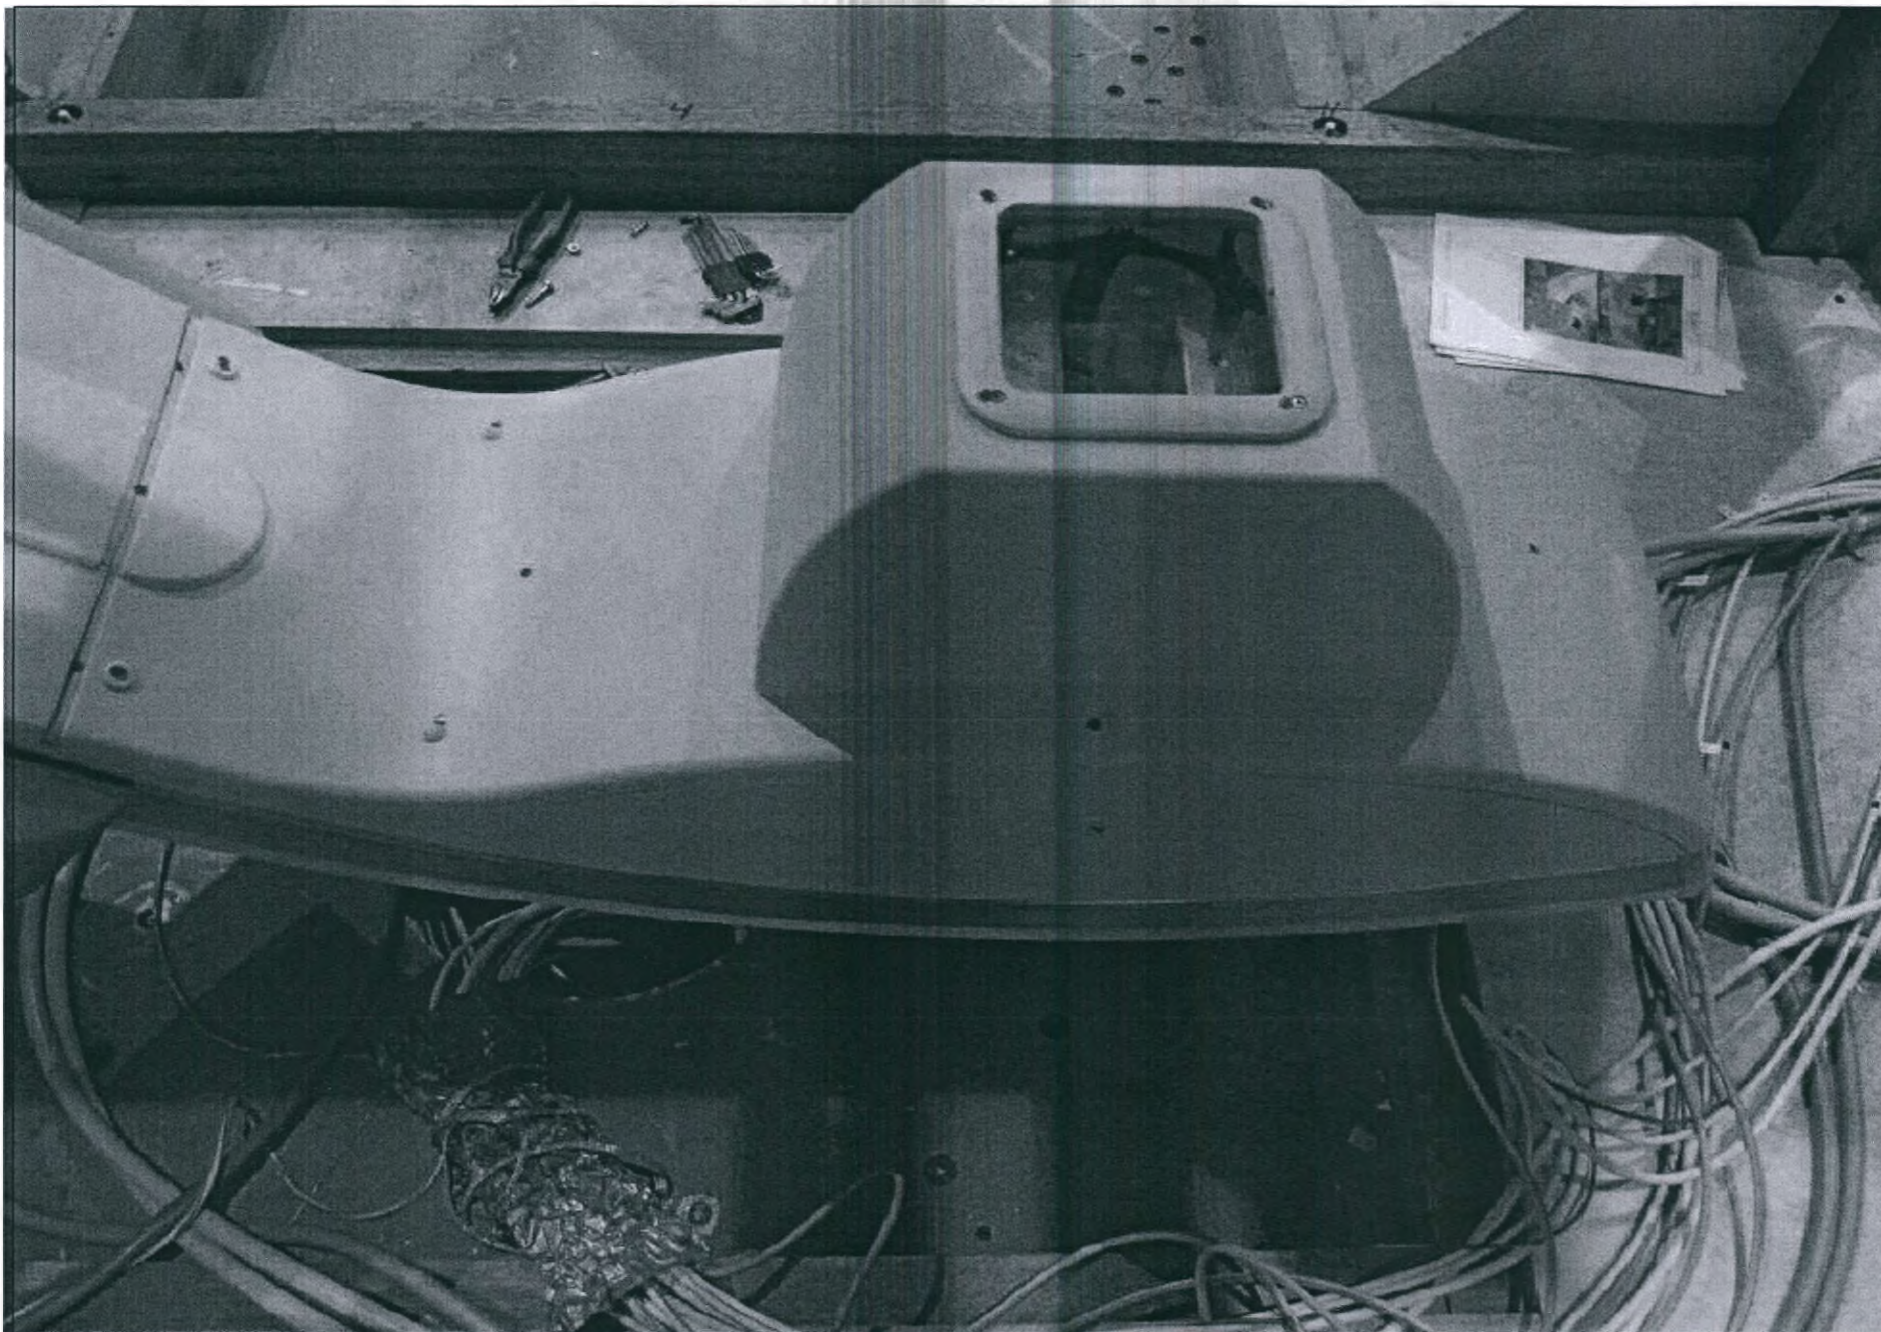


1.д. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

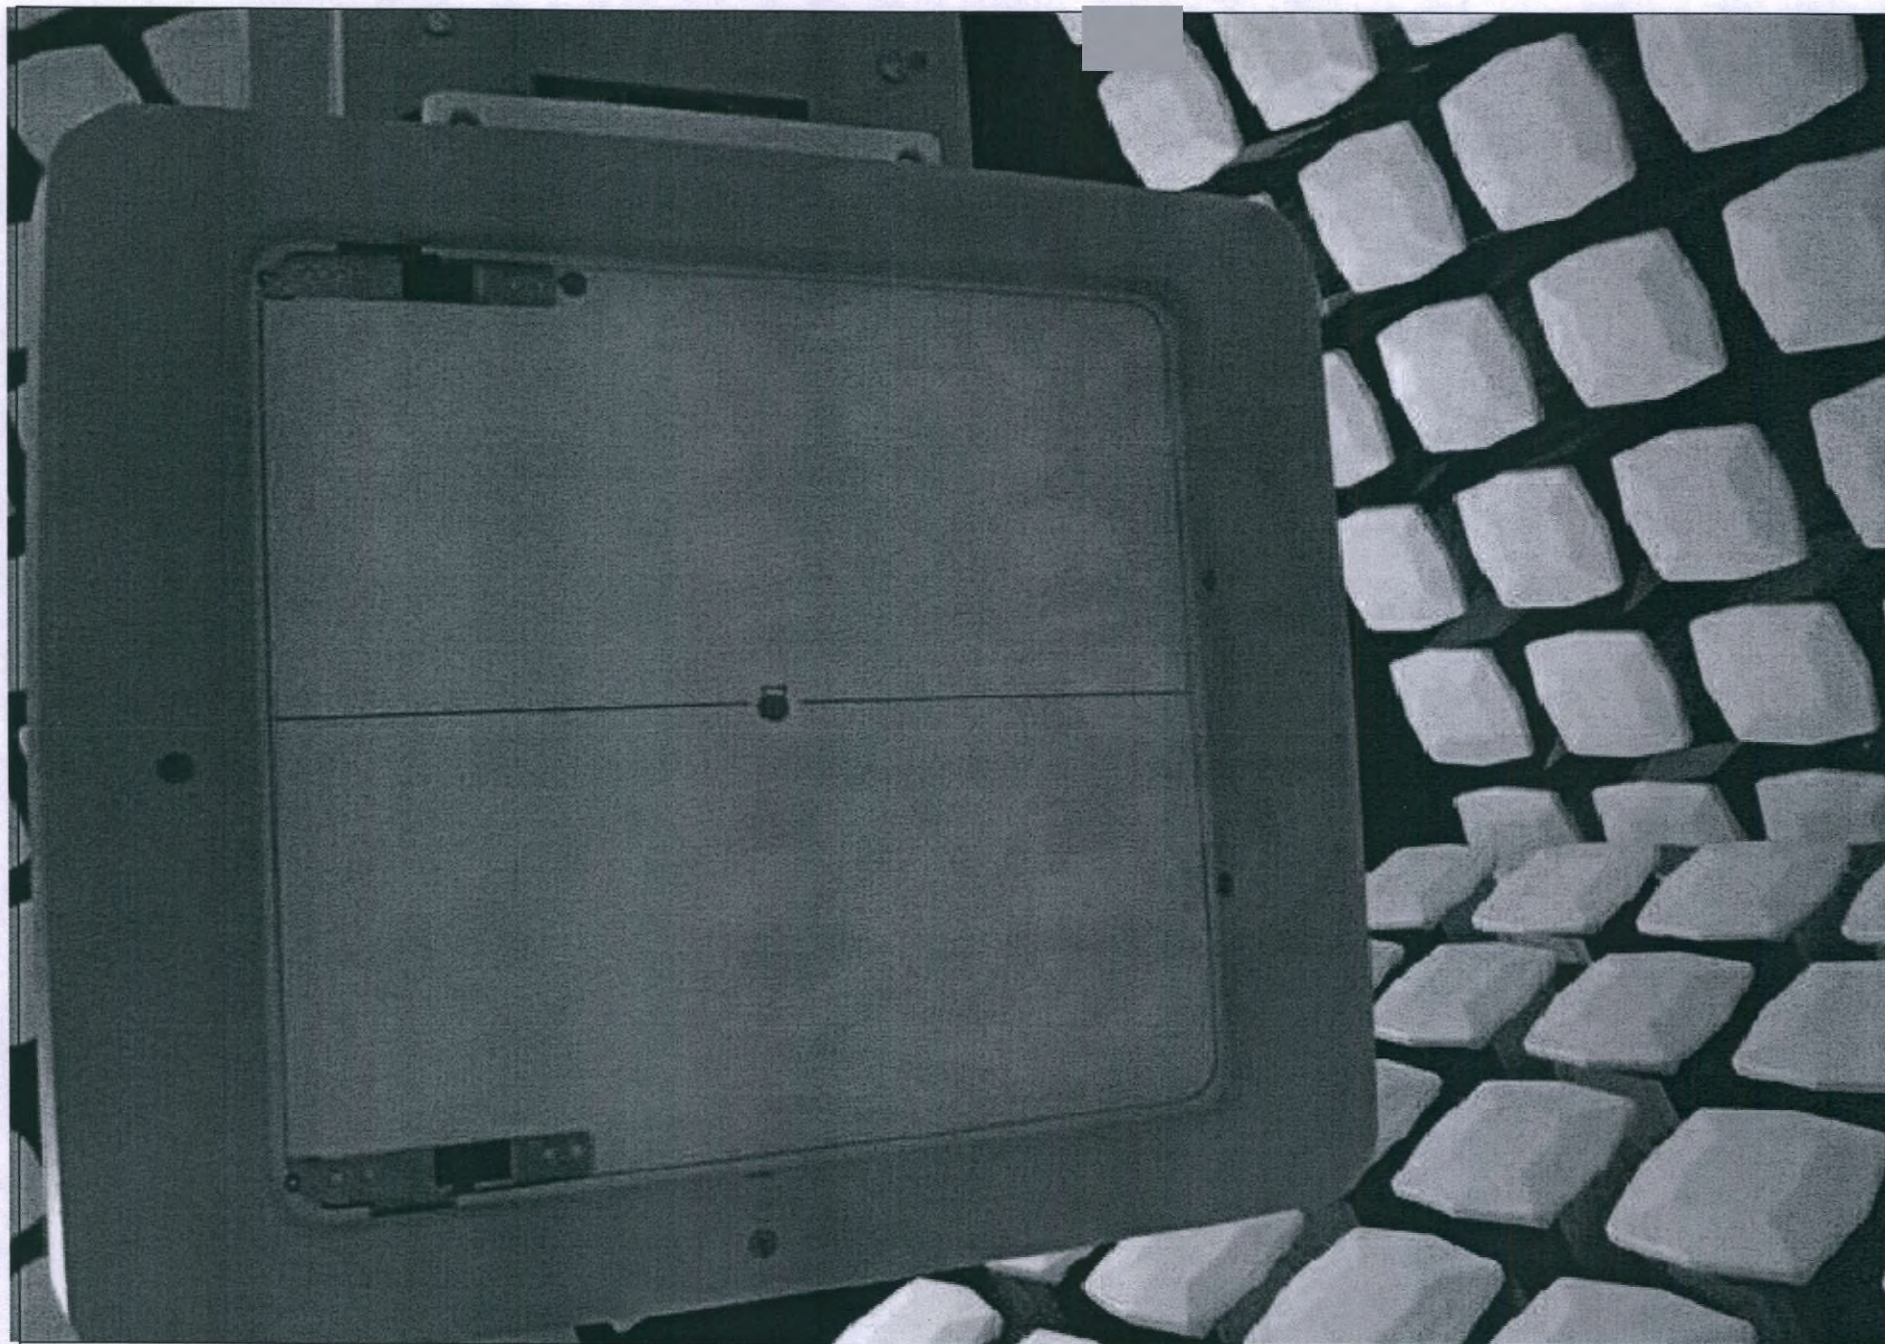


1.е. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

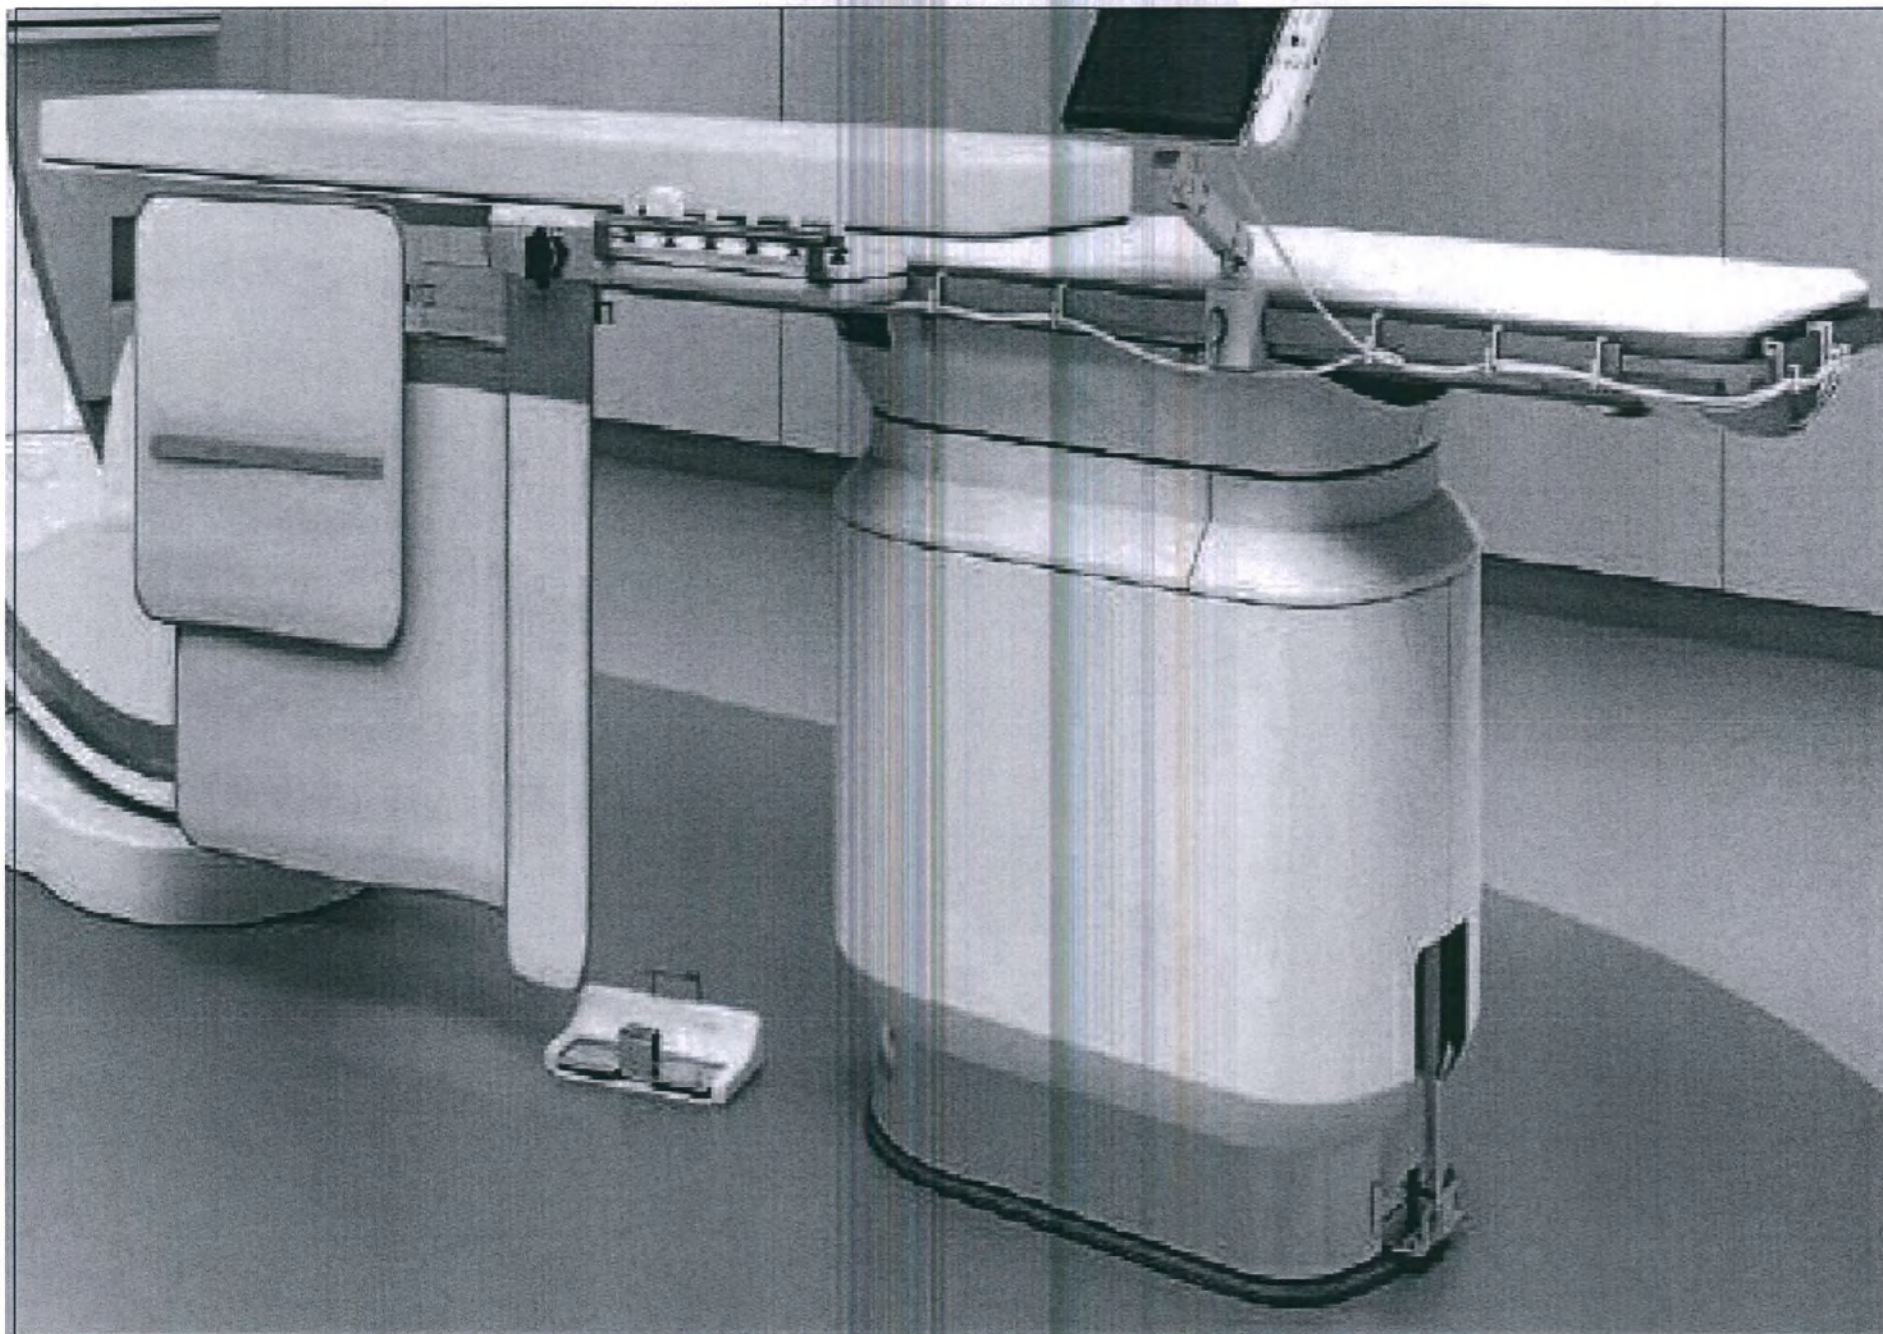


2.а. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

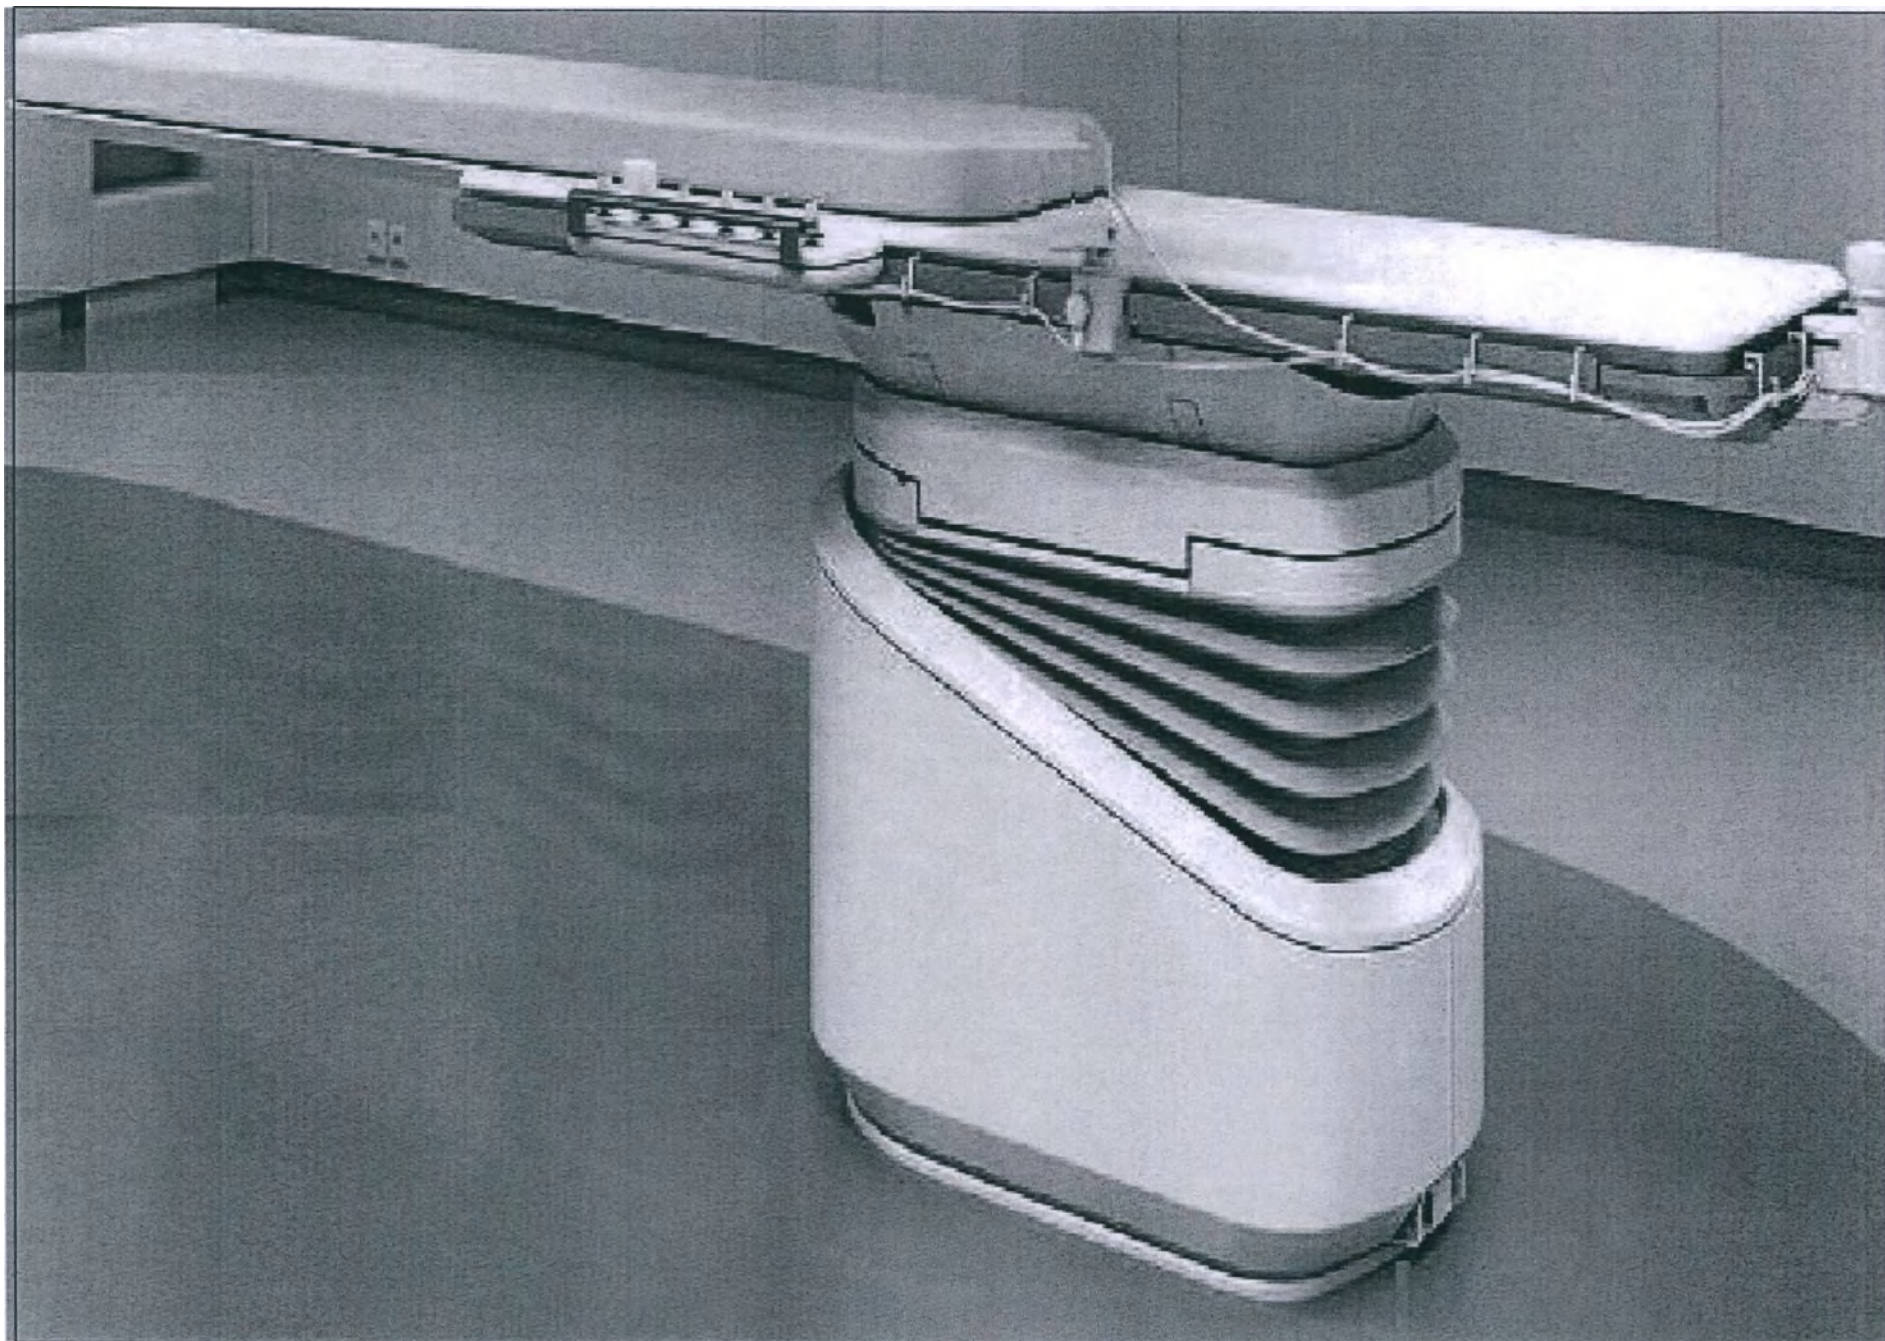


2.6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

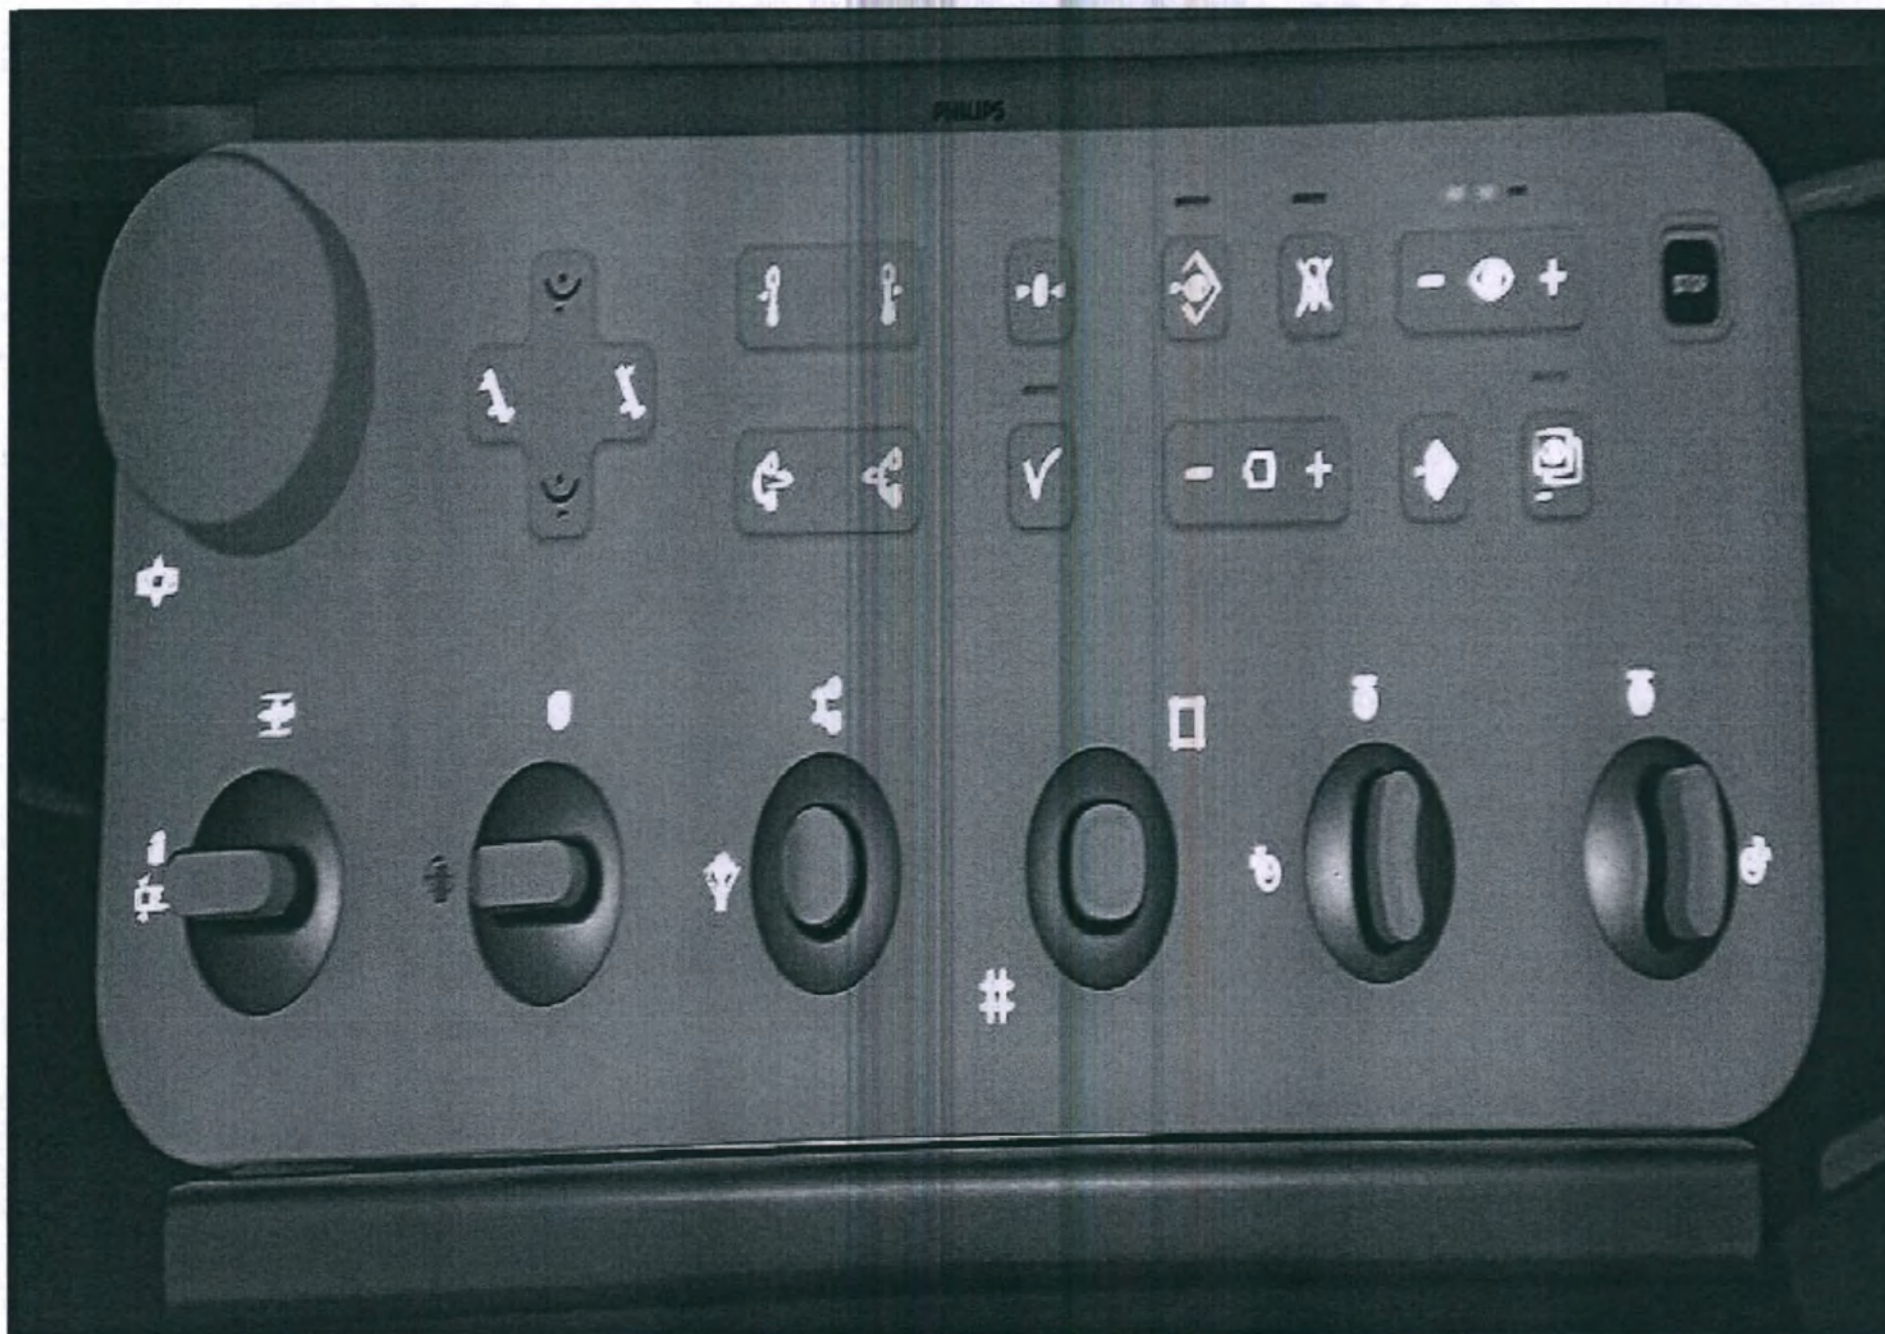


3. Модуль управления, не более 4 шт.

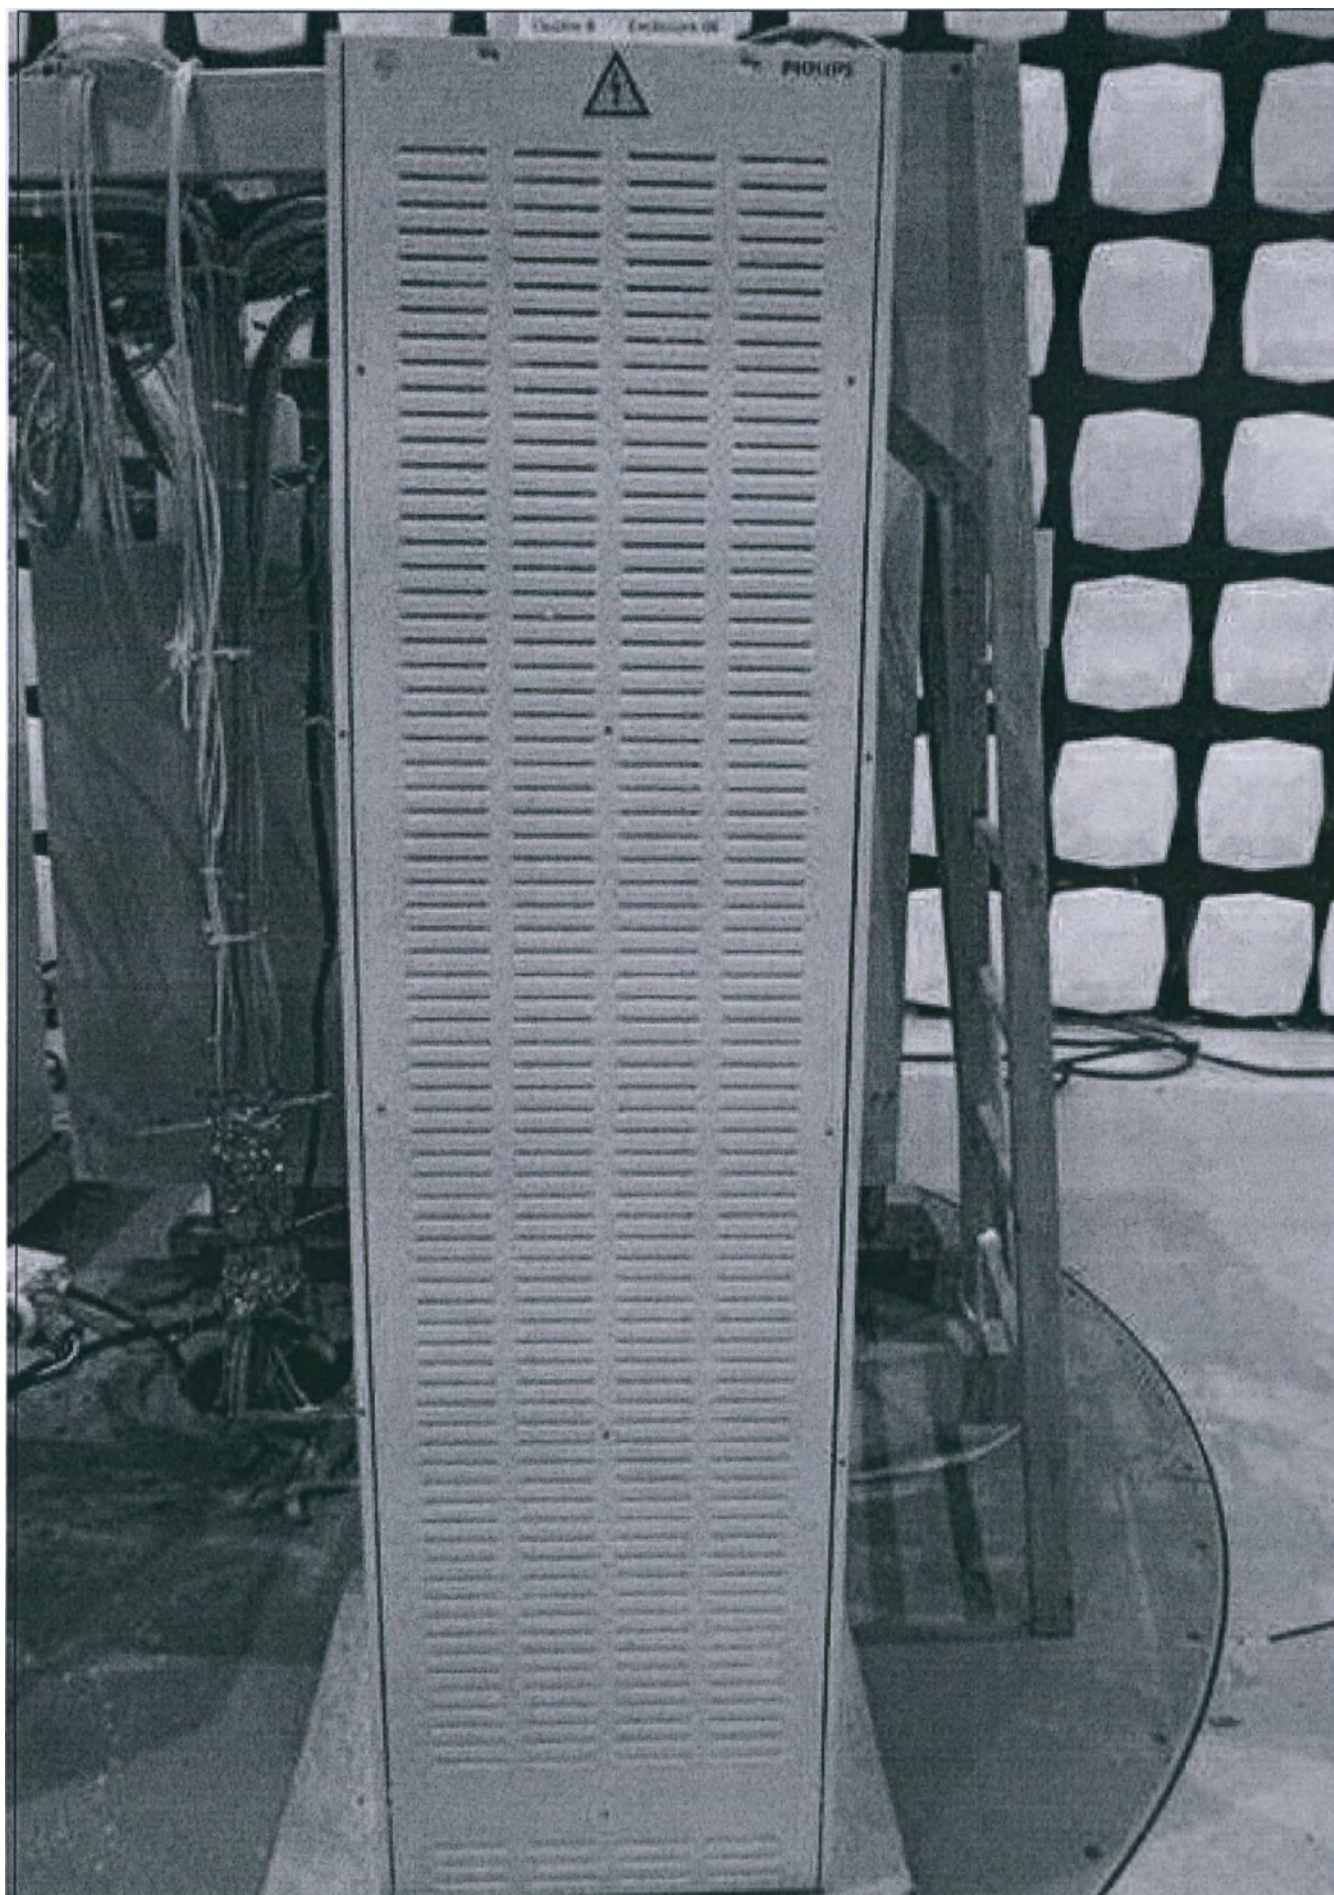


4.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

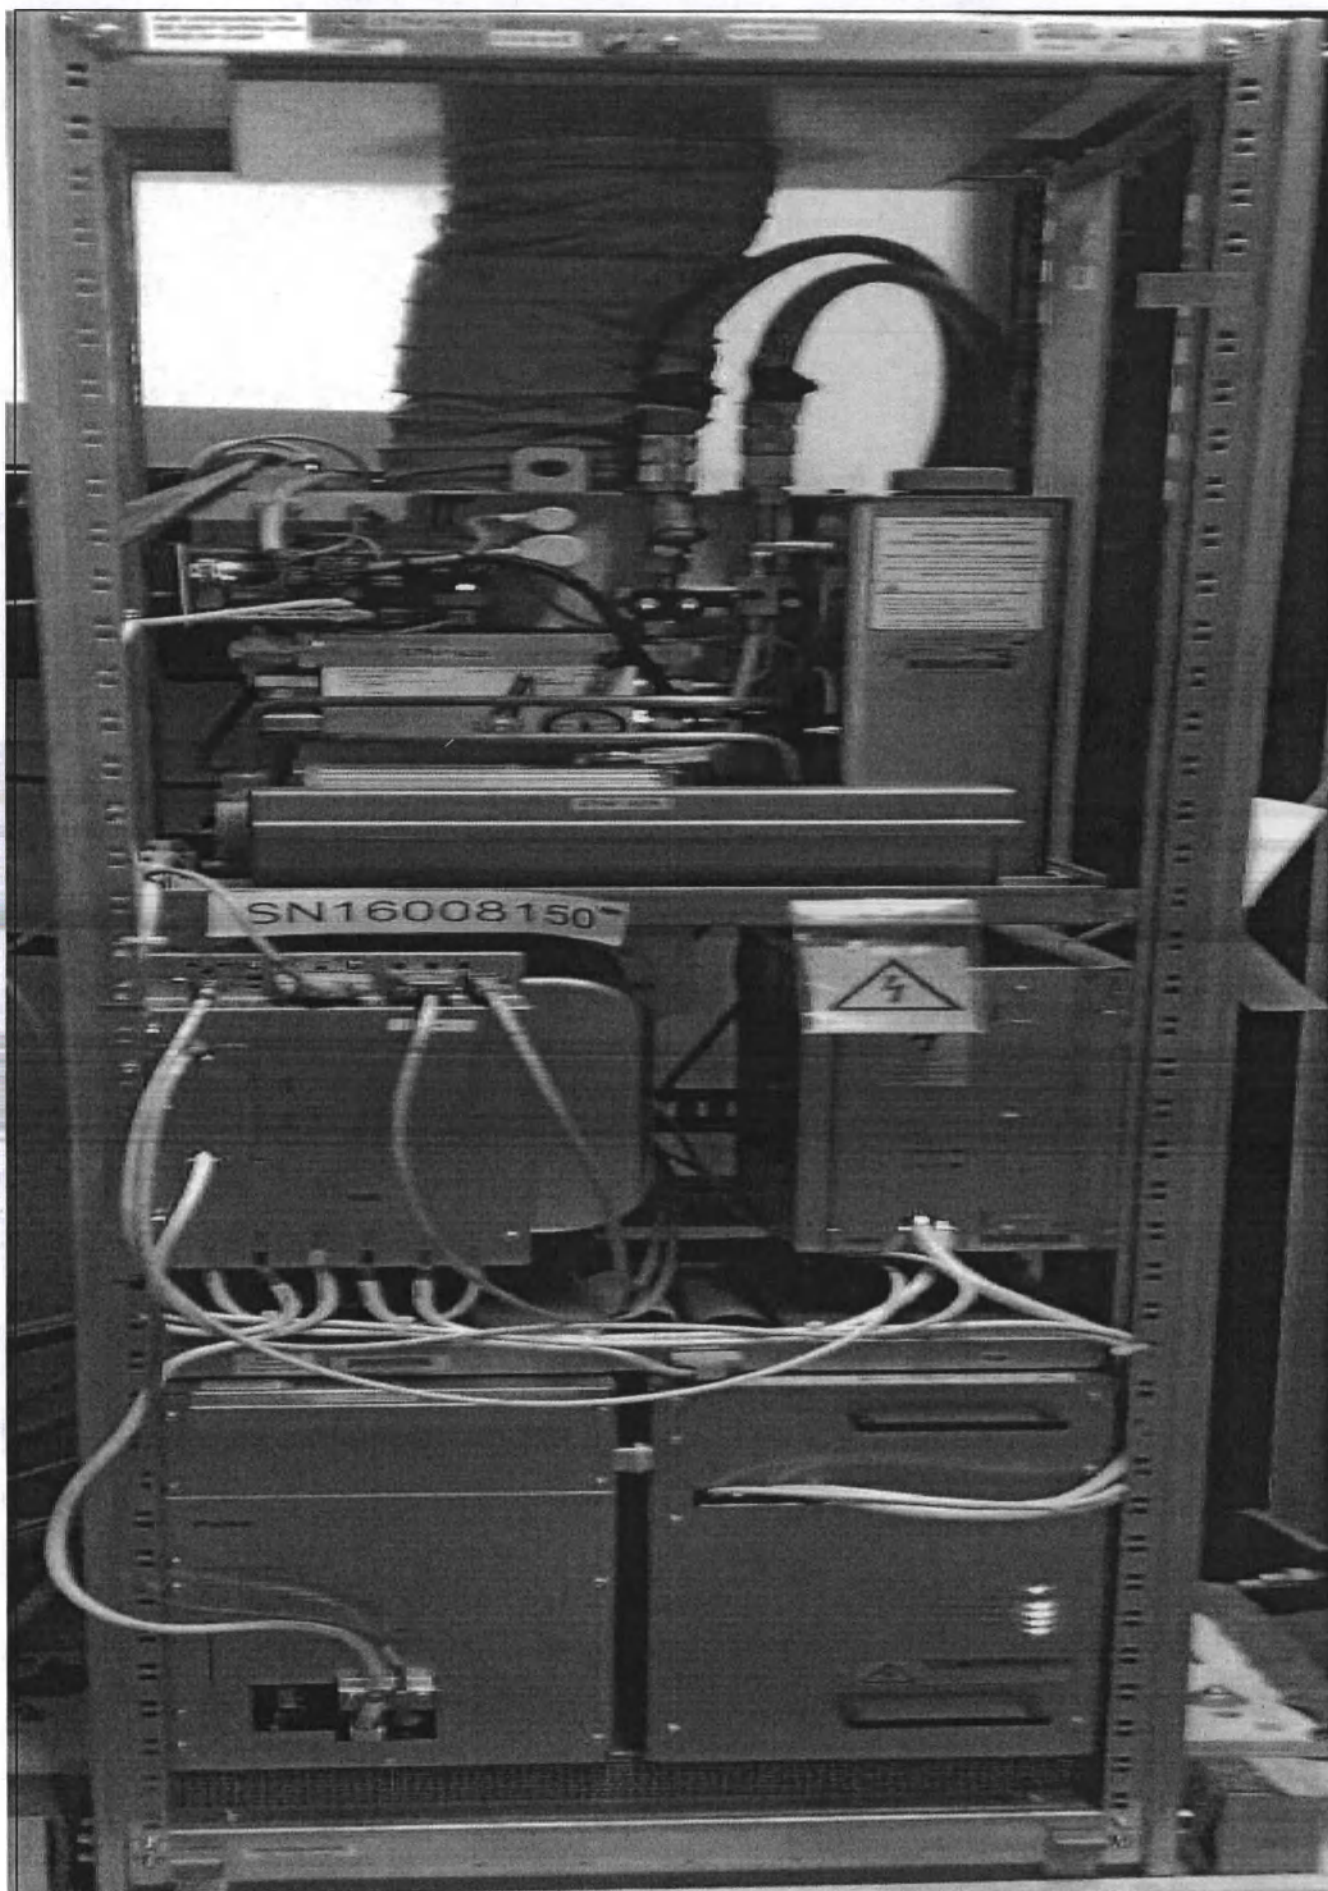


4.6. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

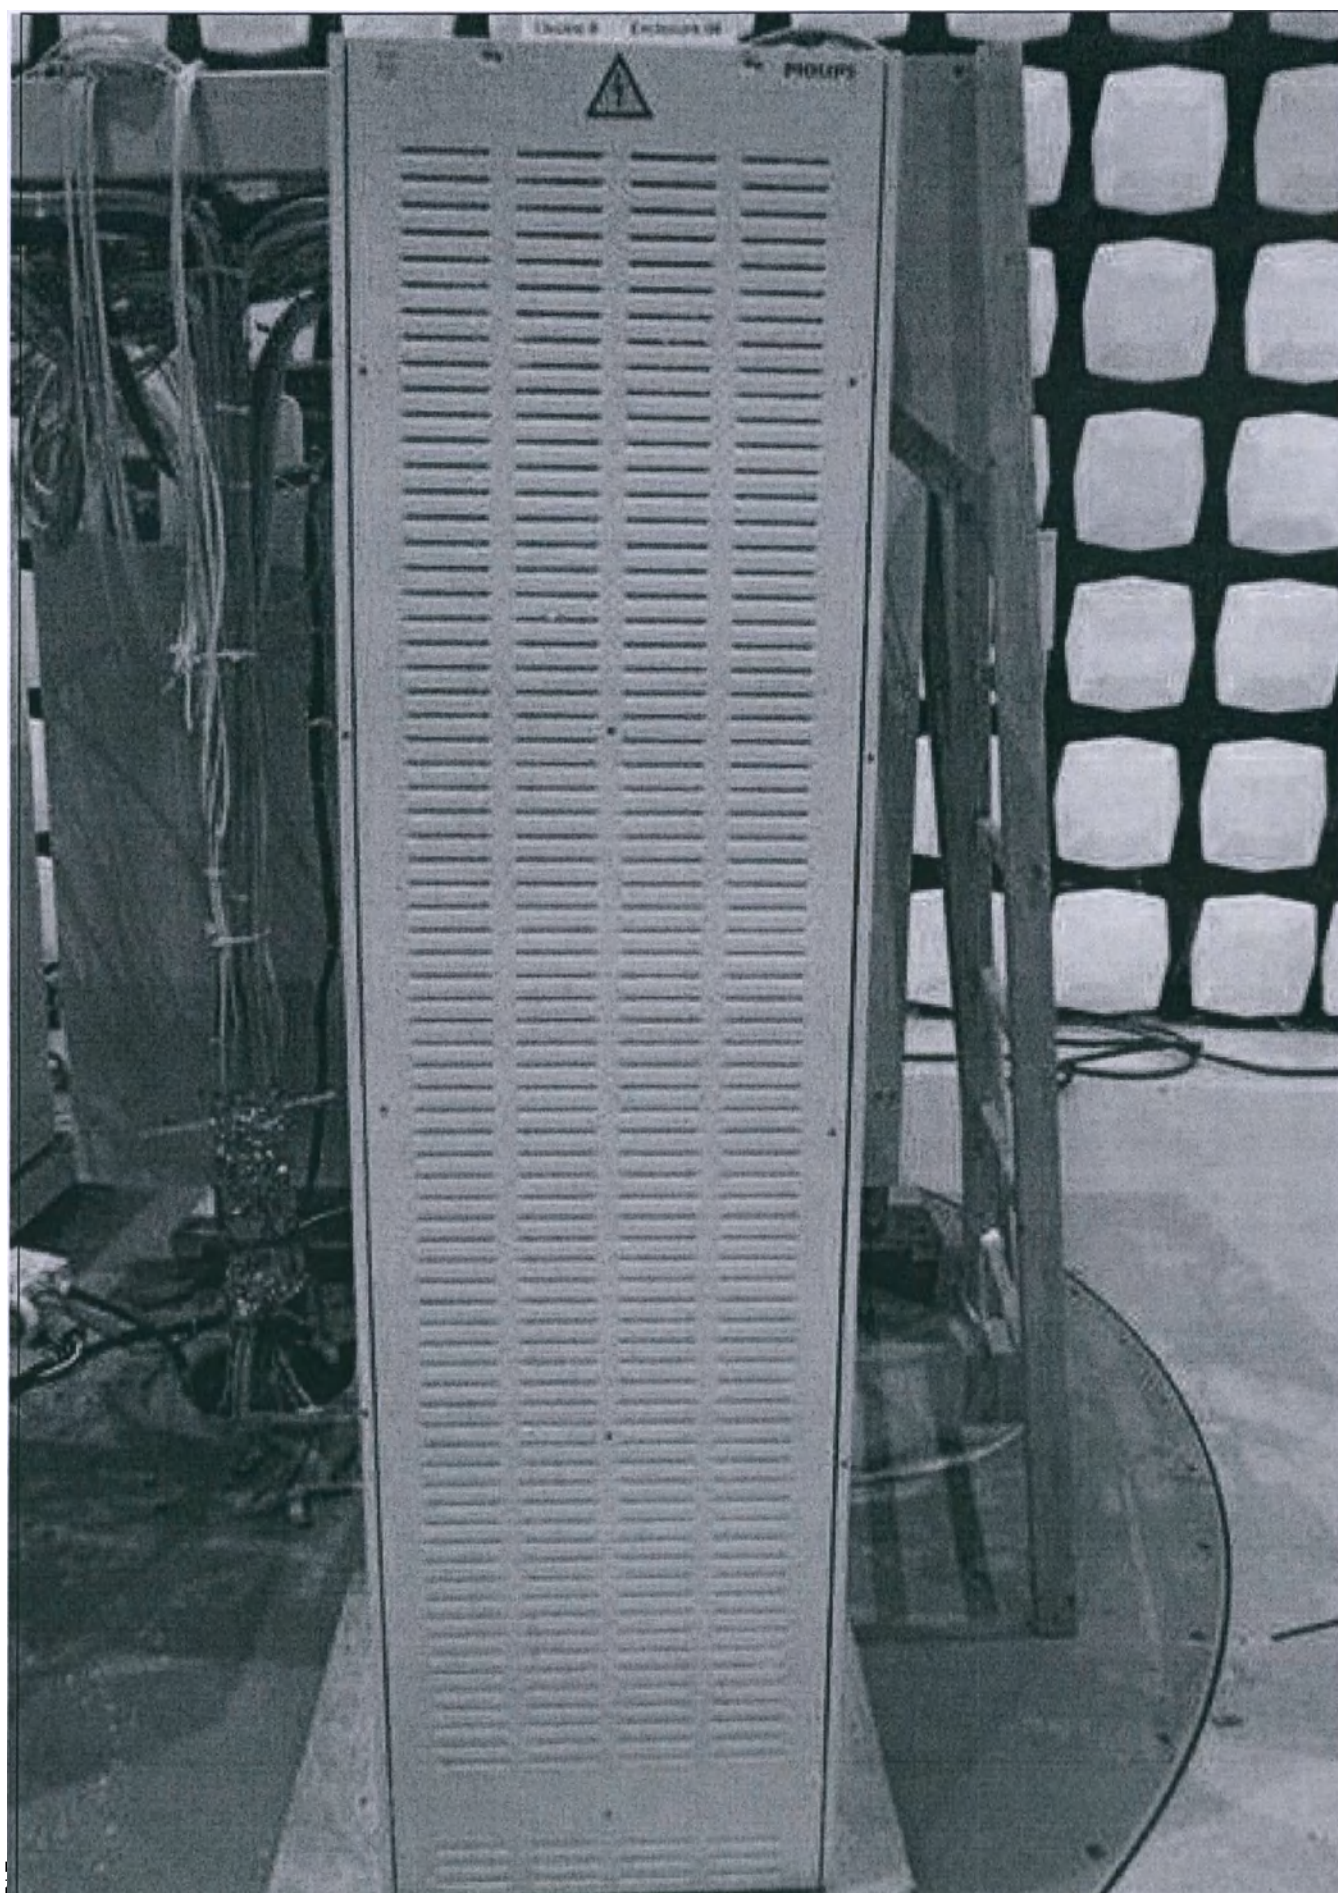


5.а. Шкаф управления.

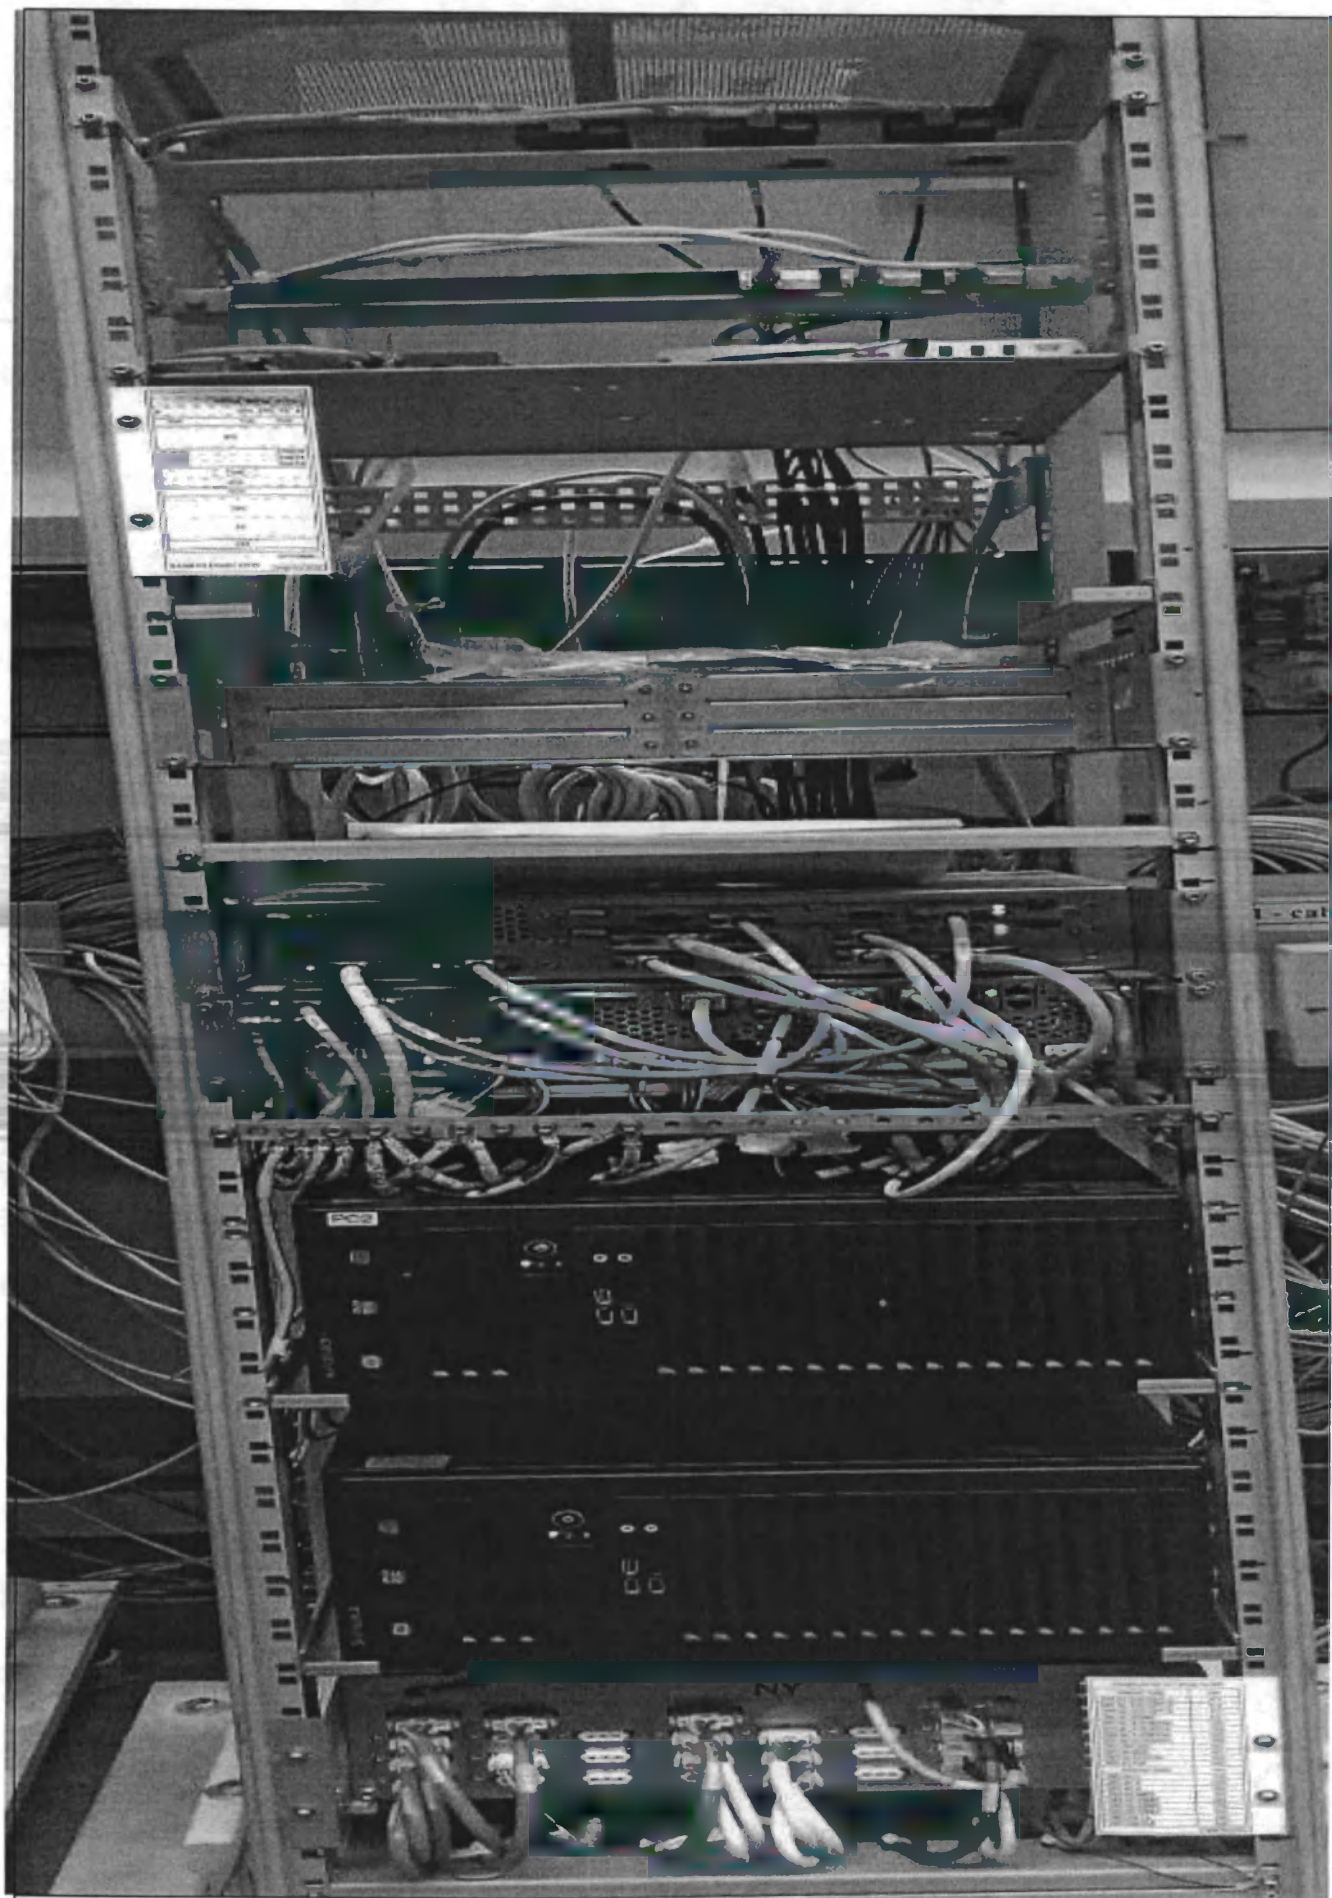

5.6. Шкаф управления.

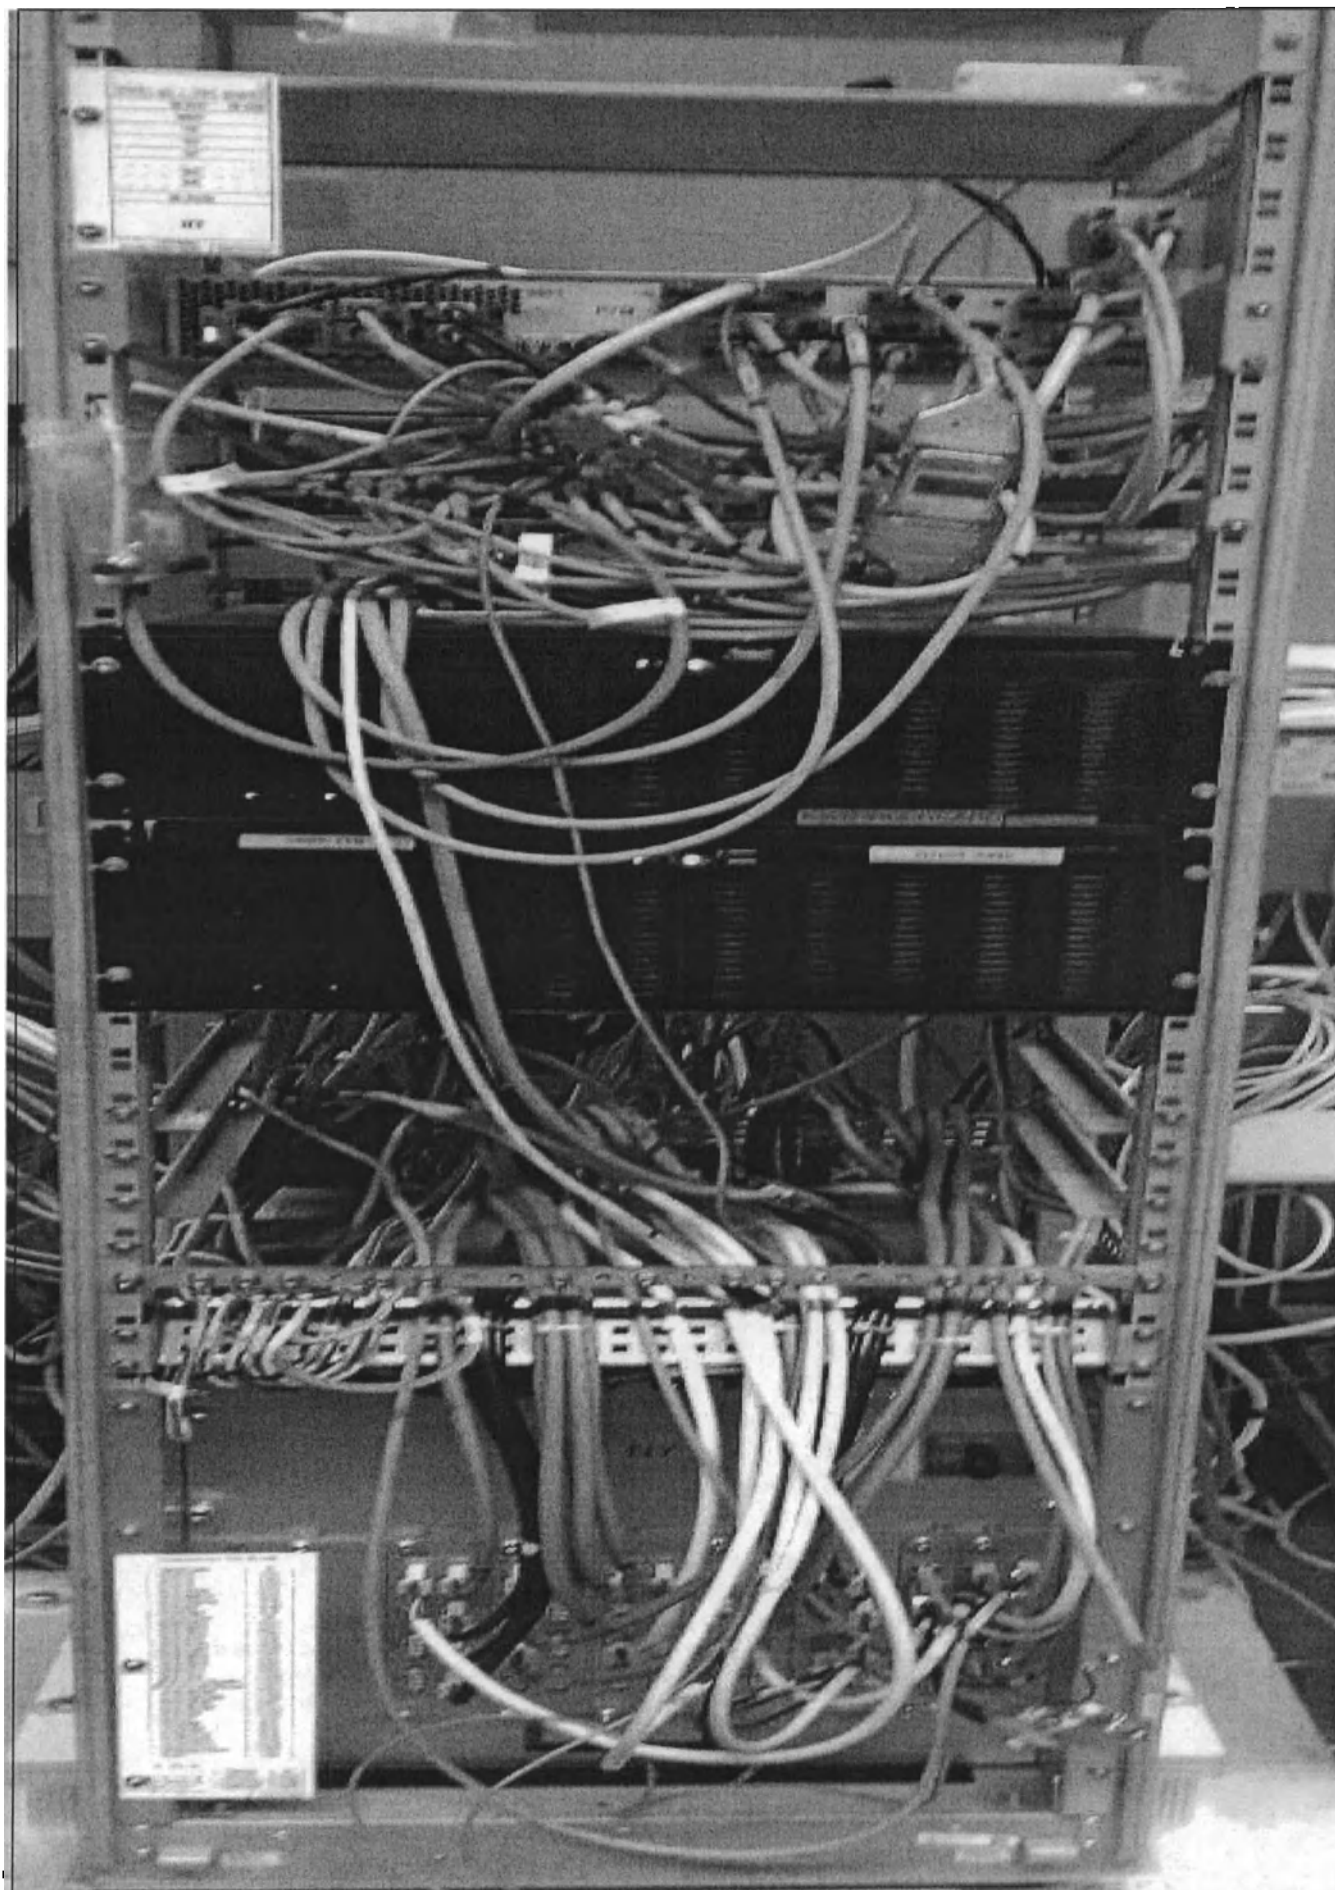


6.а. Распределительный щит.

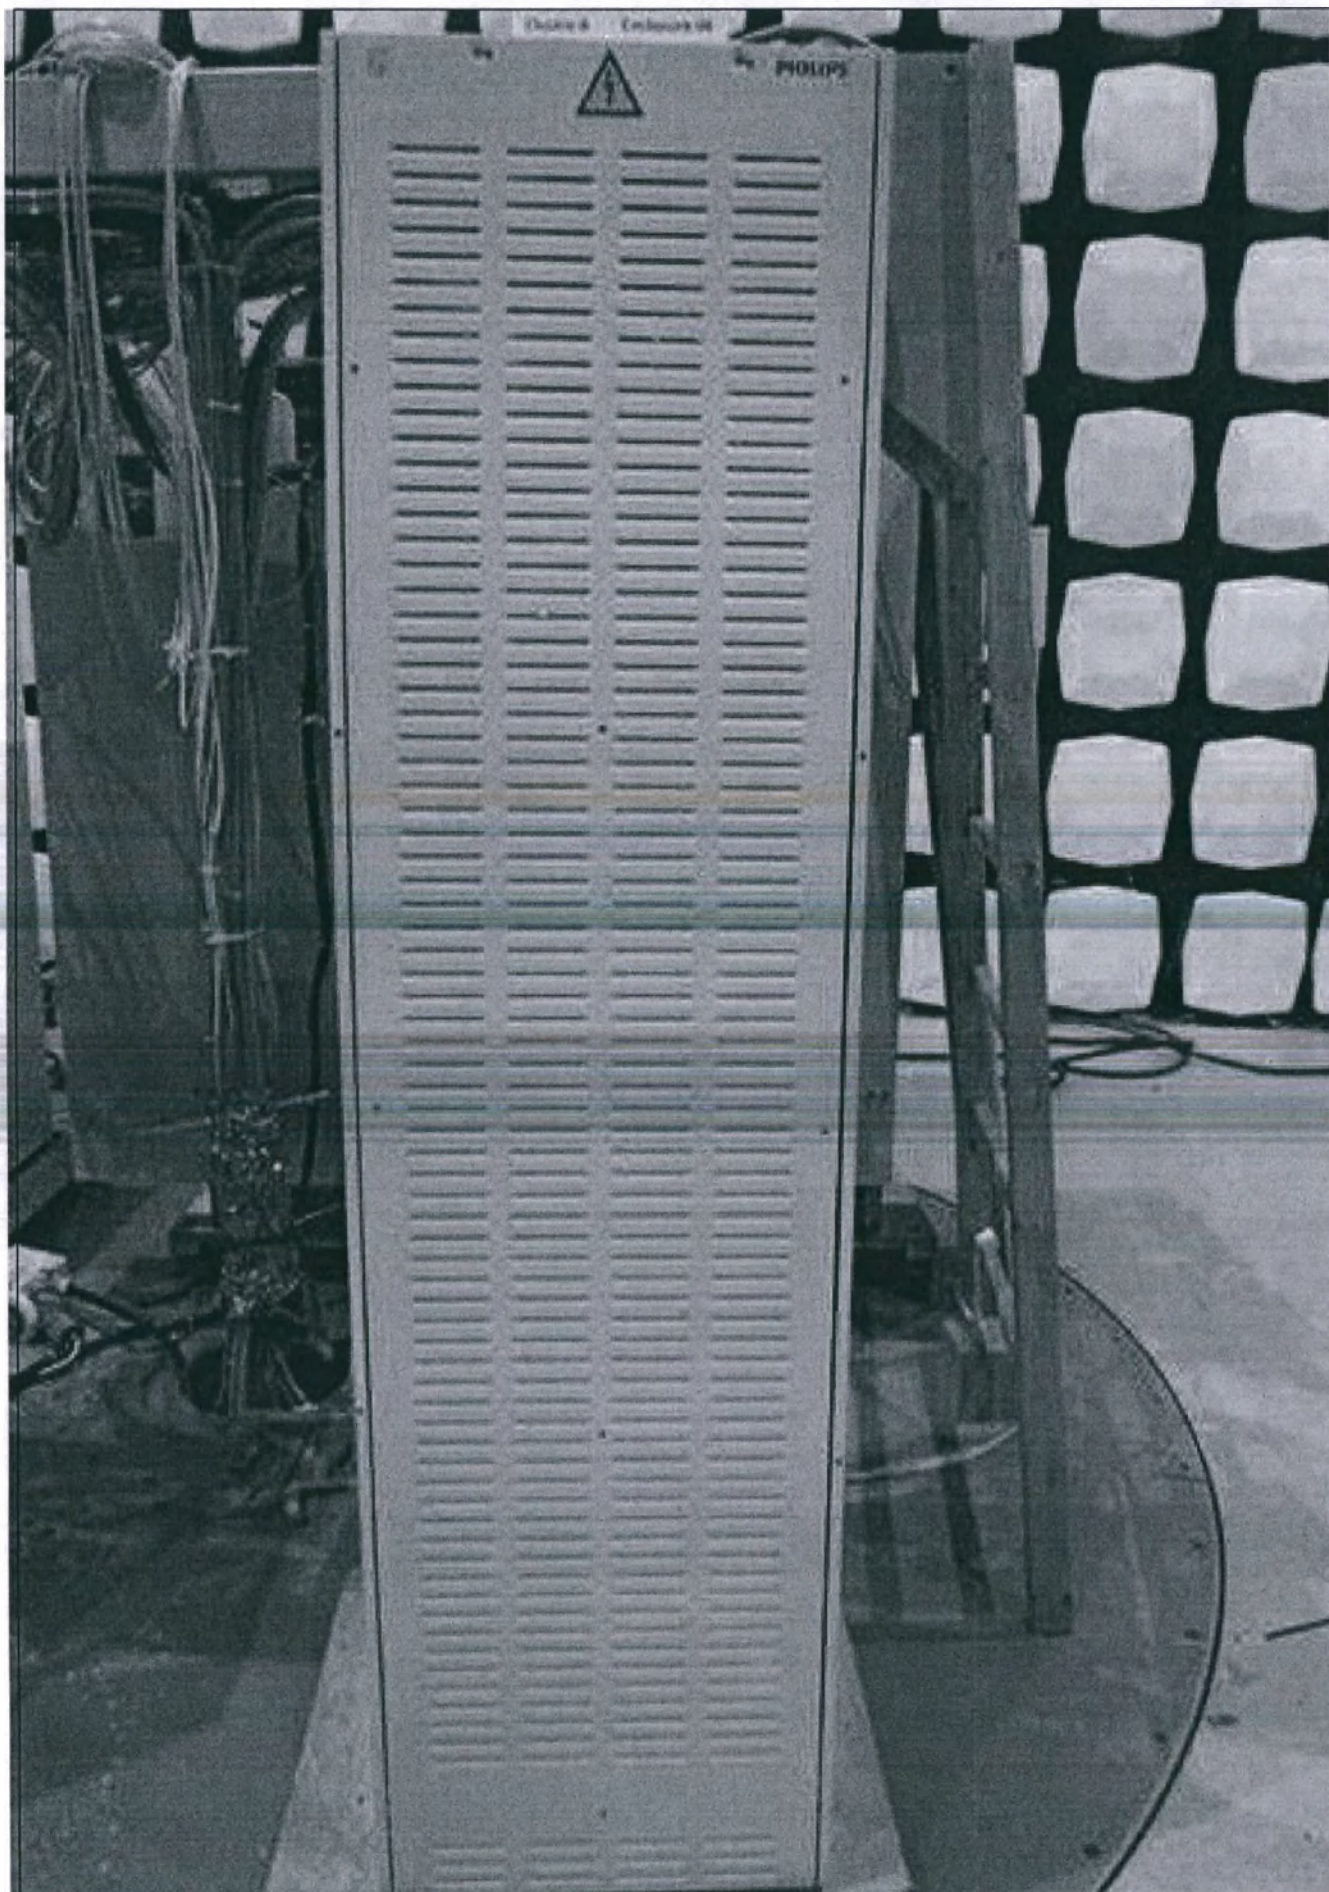


6.6. Распределительный щит.




7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

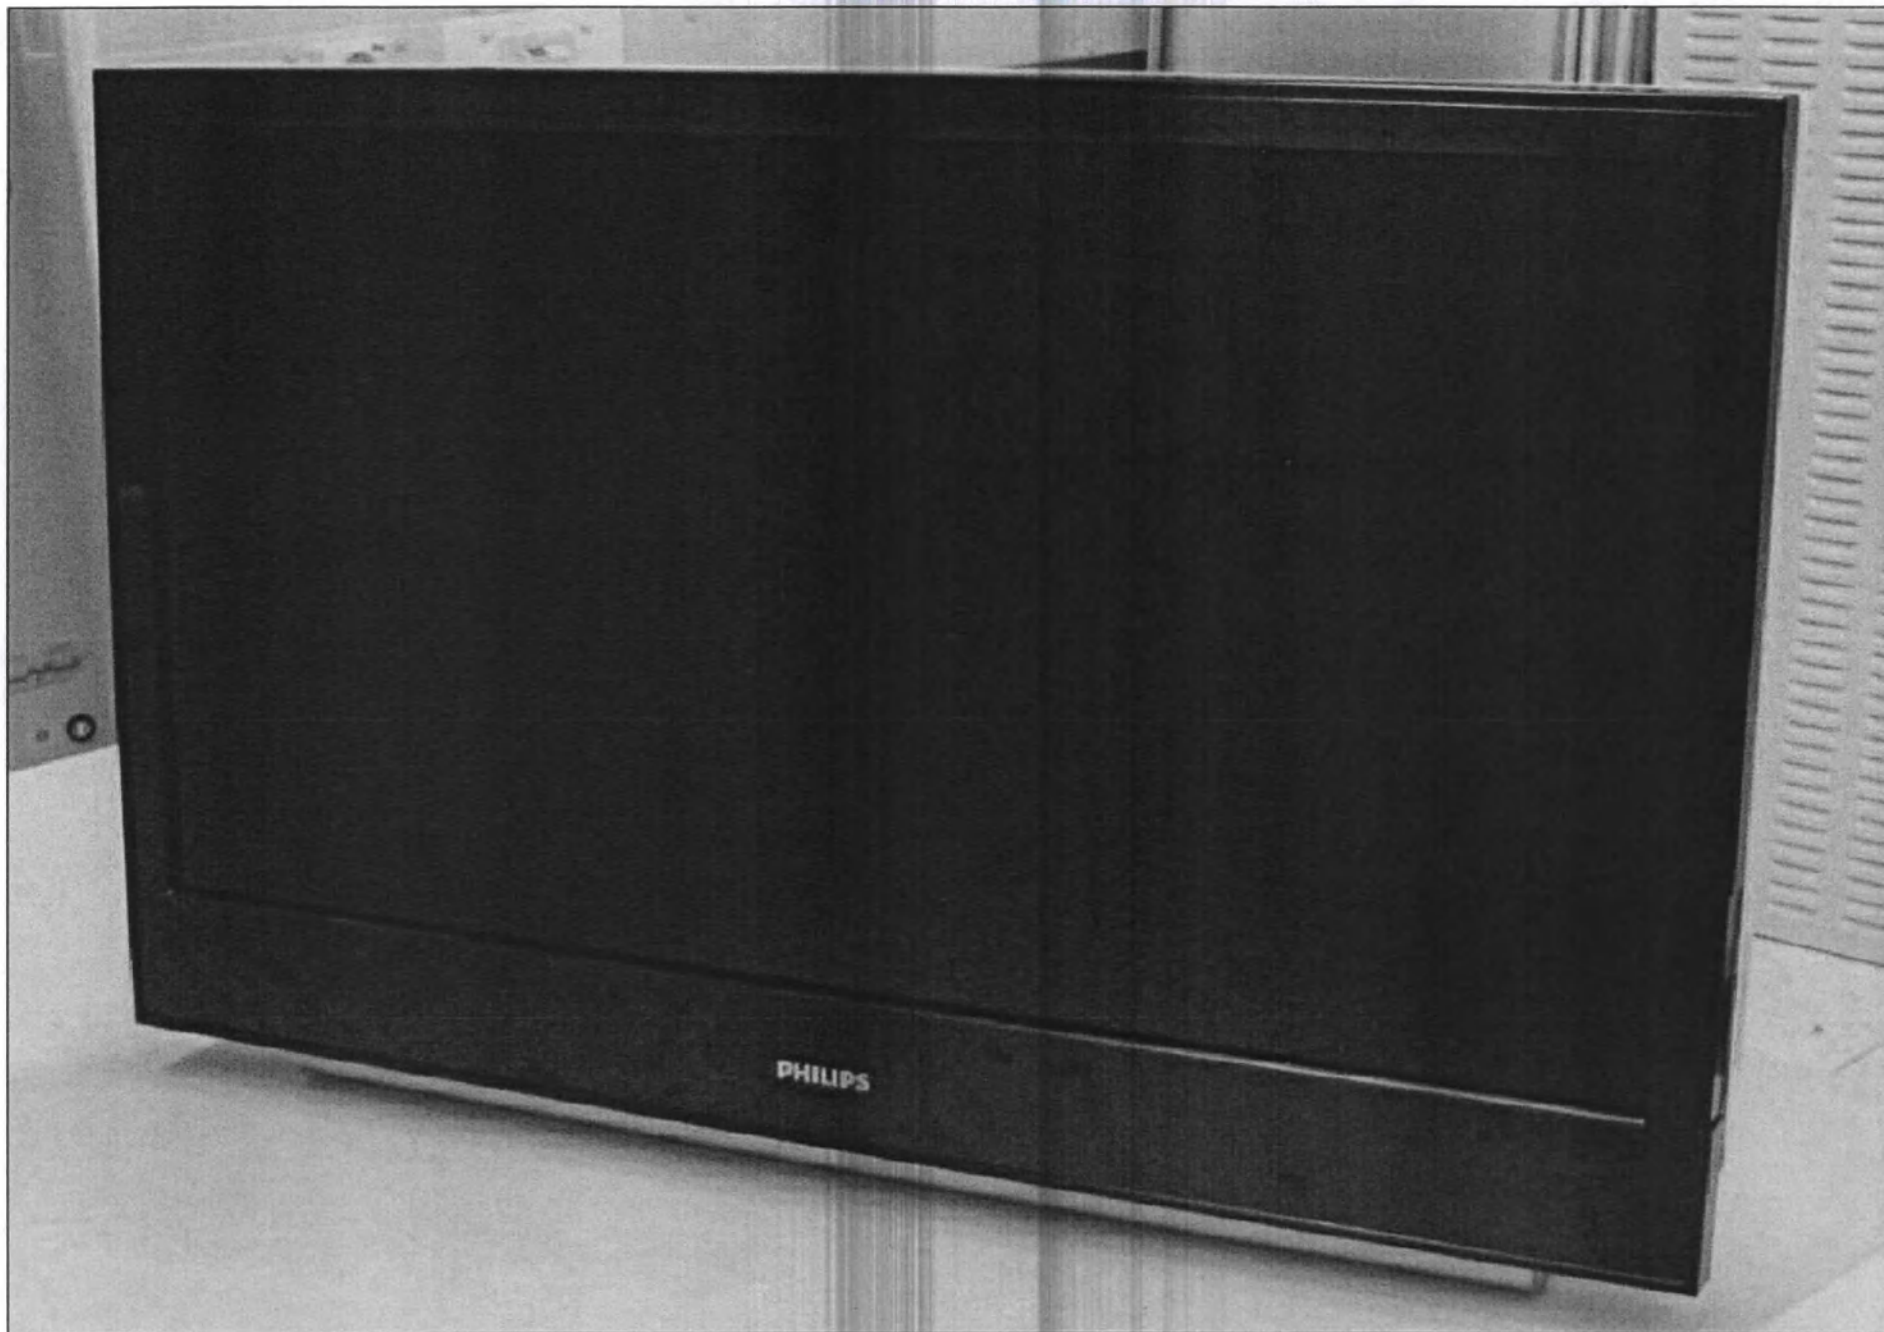

8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

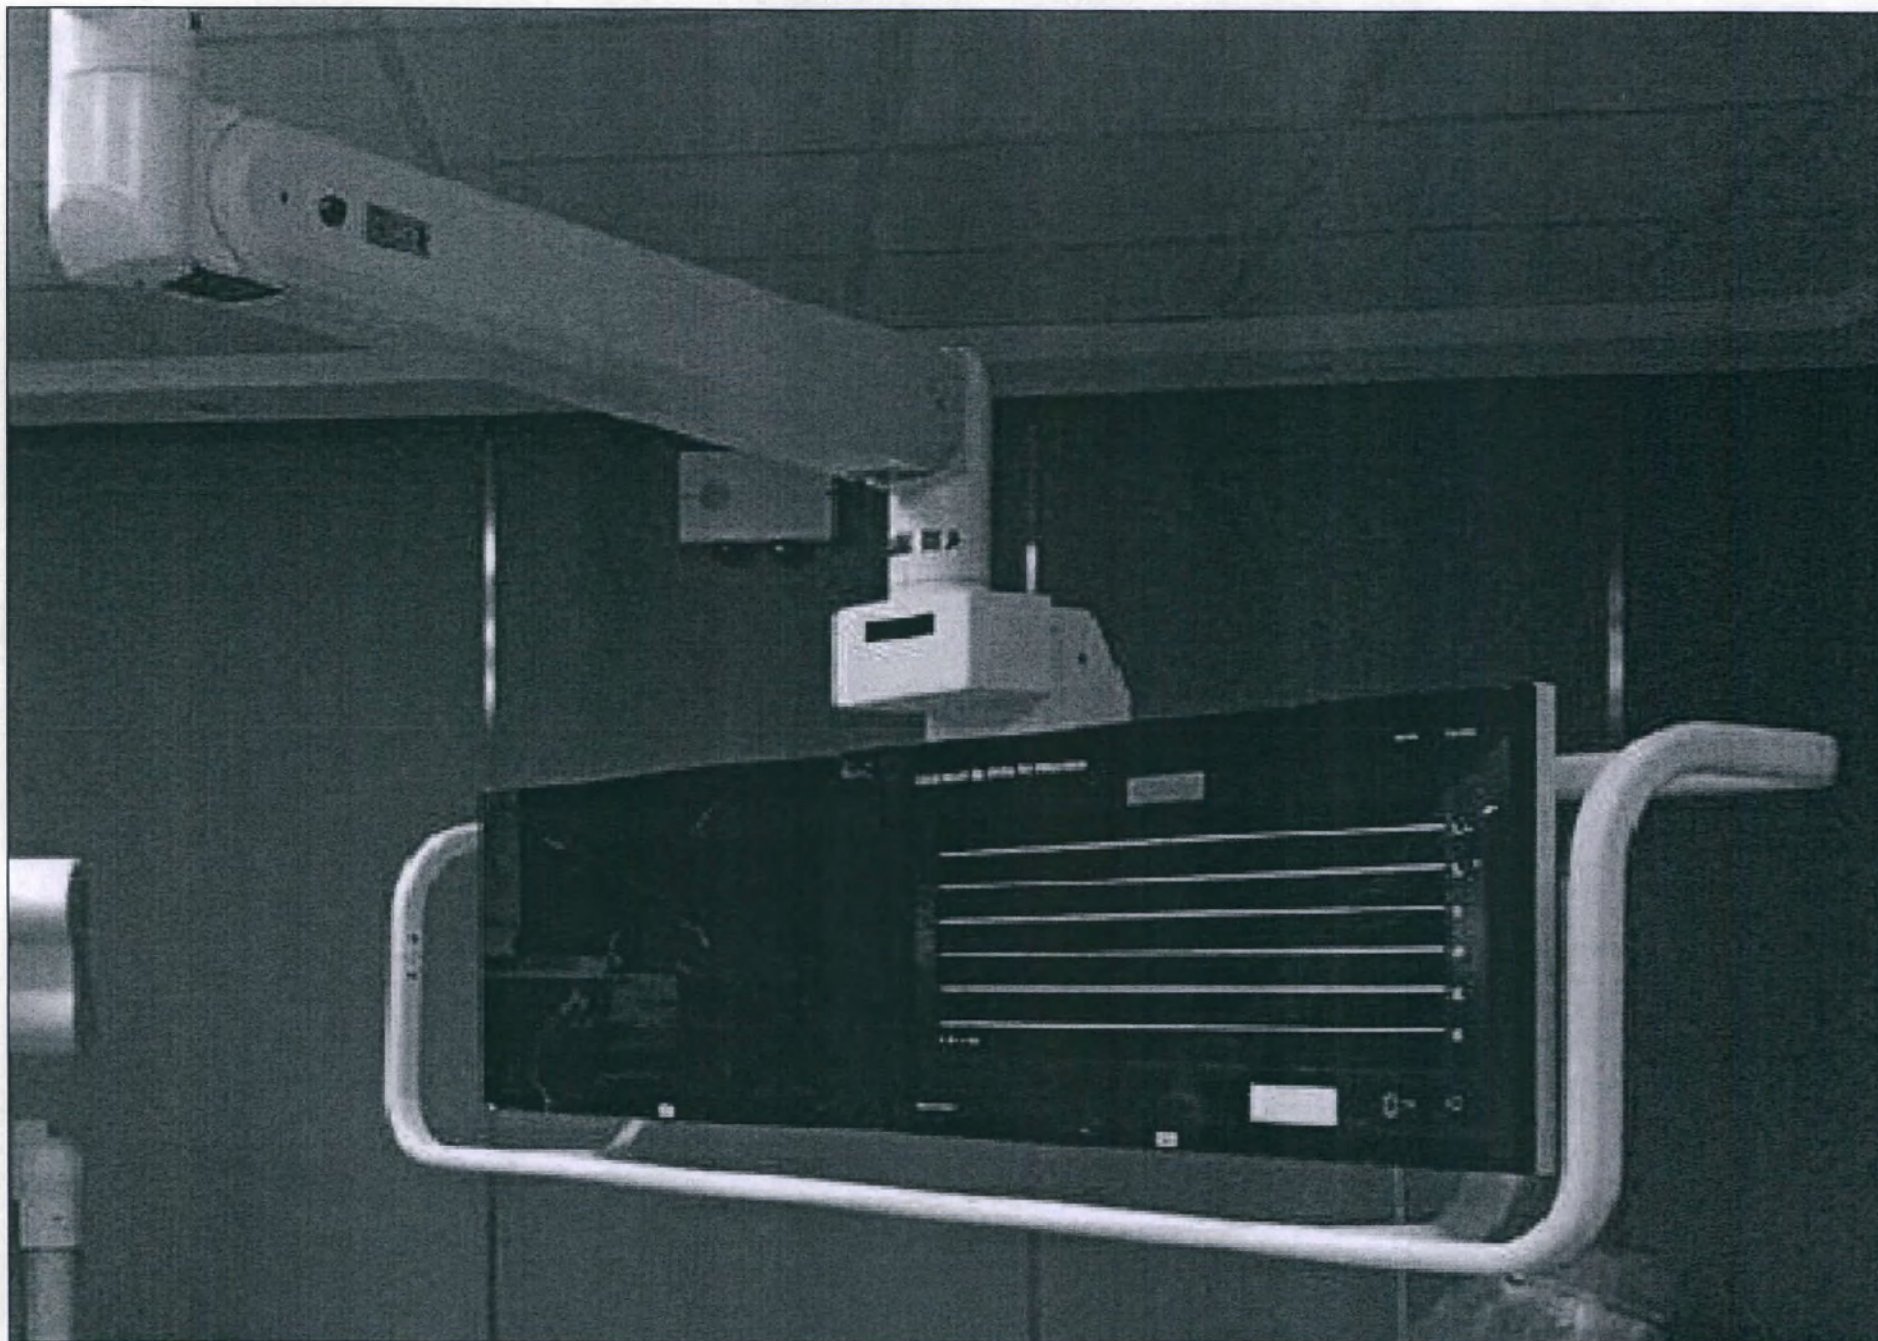


9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

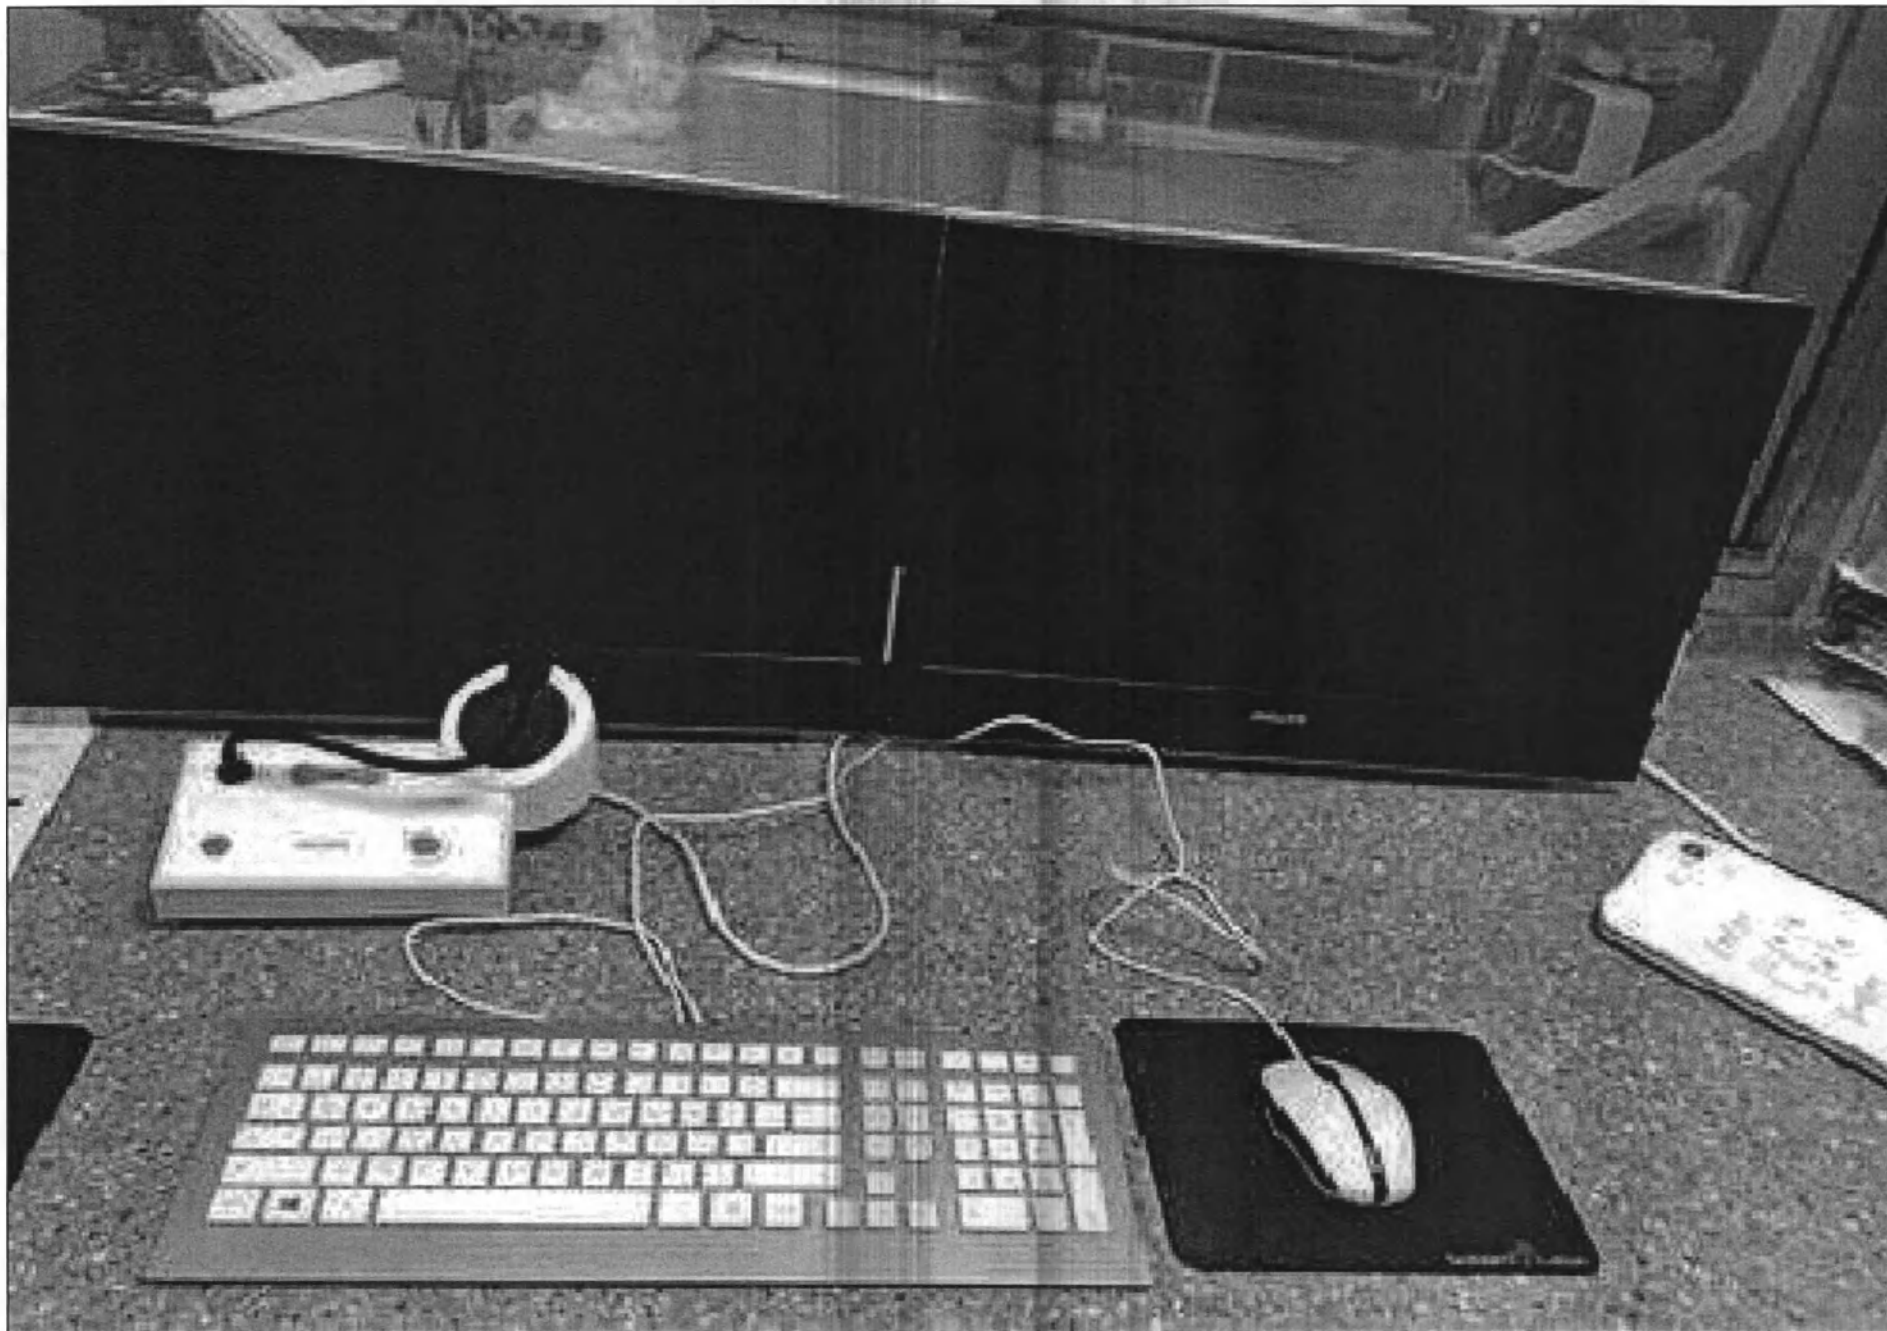


10.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.




10.6. Оборудование пультавой в составе: Мониторы цветные для пультавой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

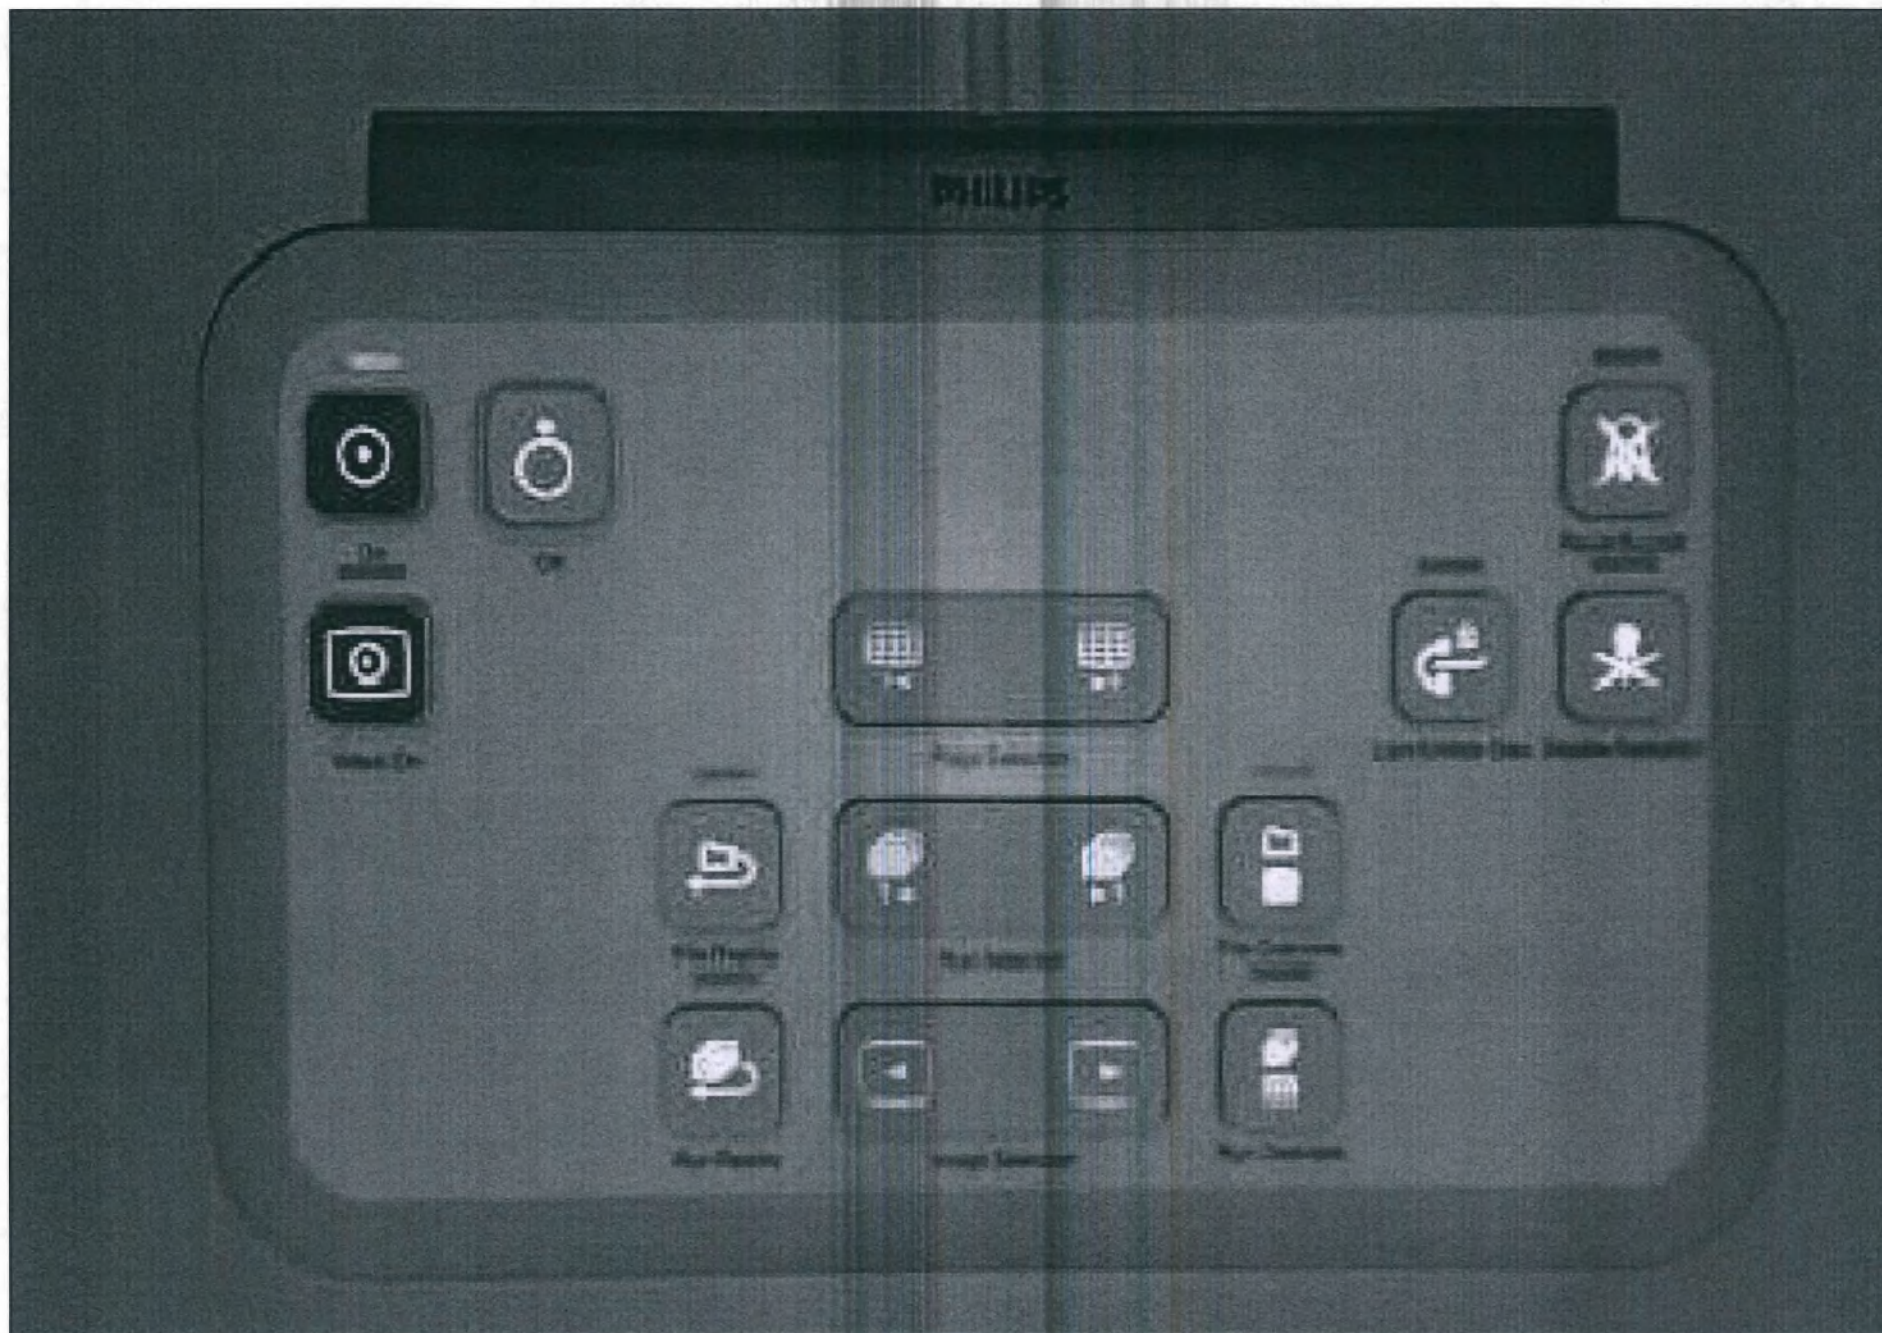


10.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

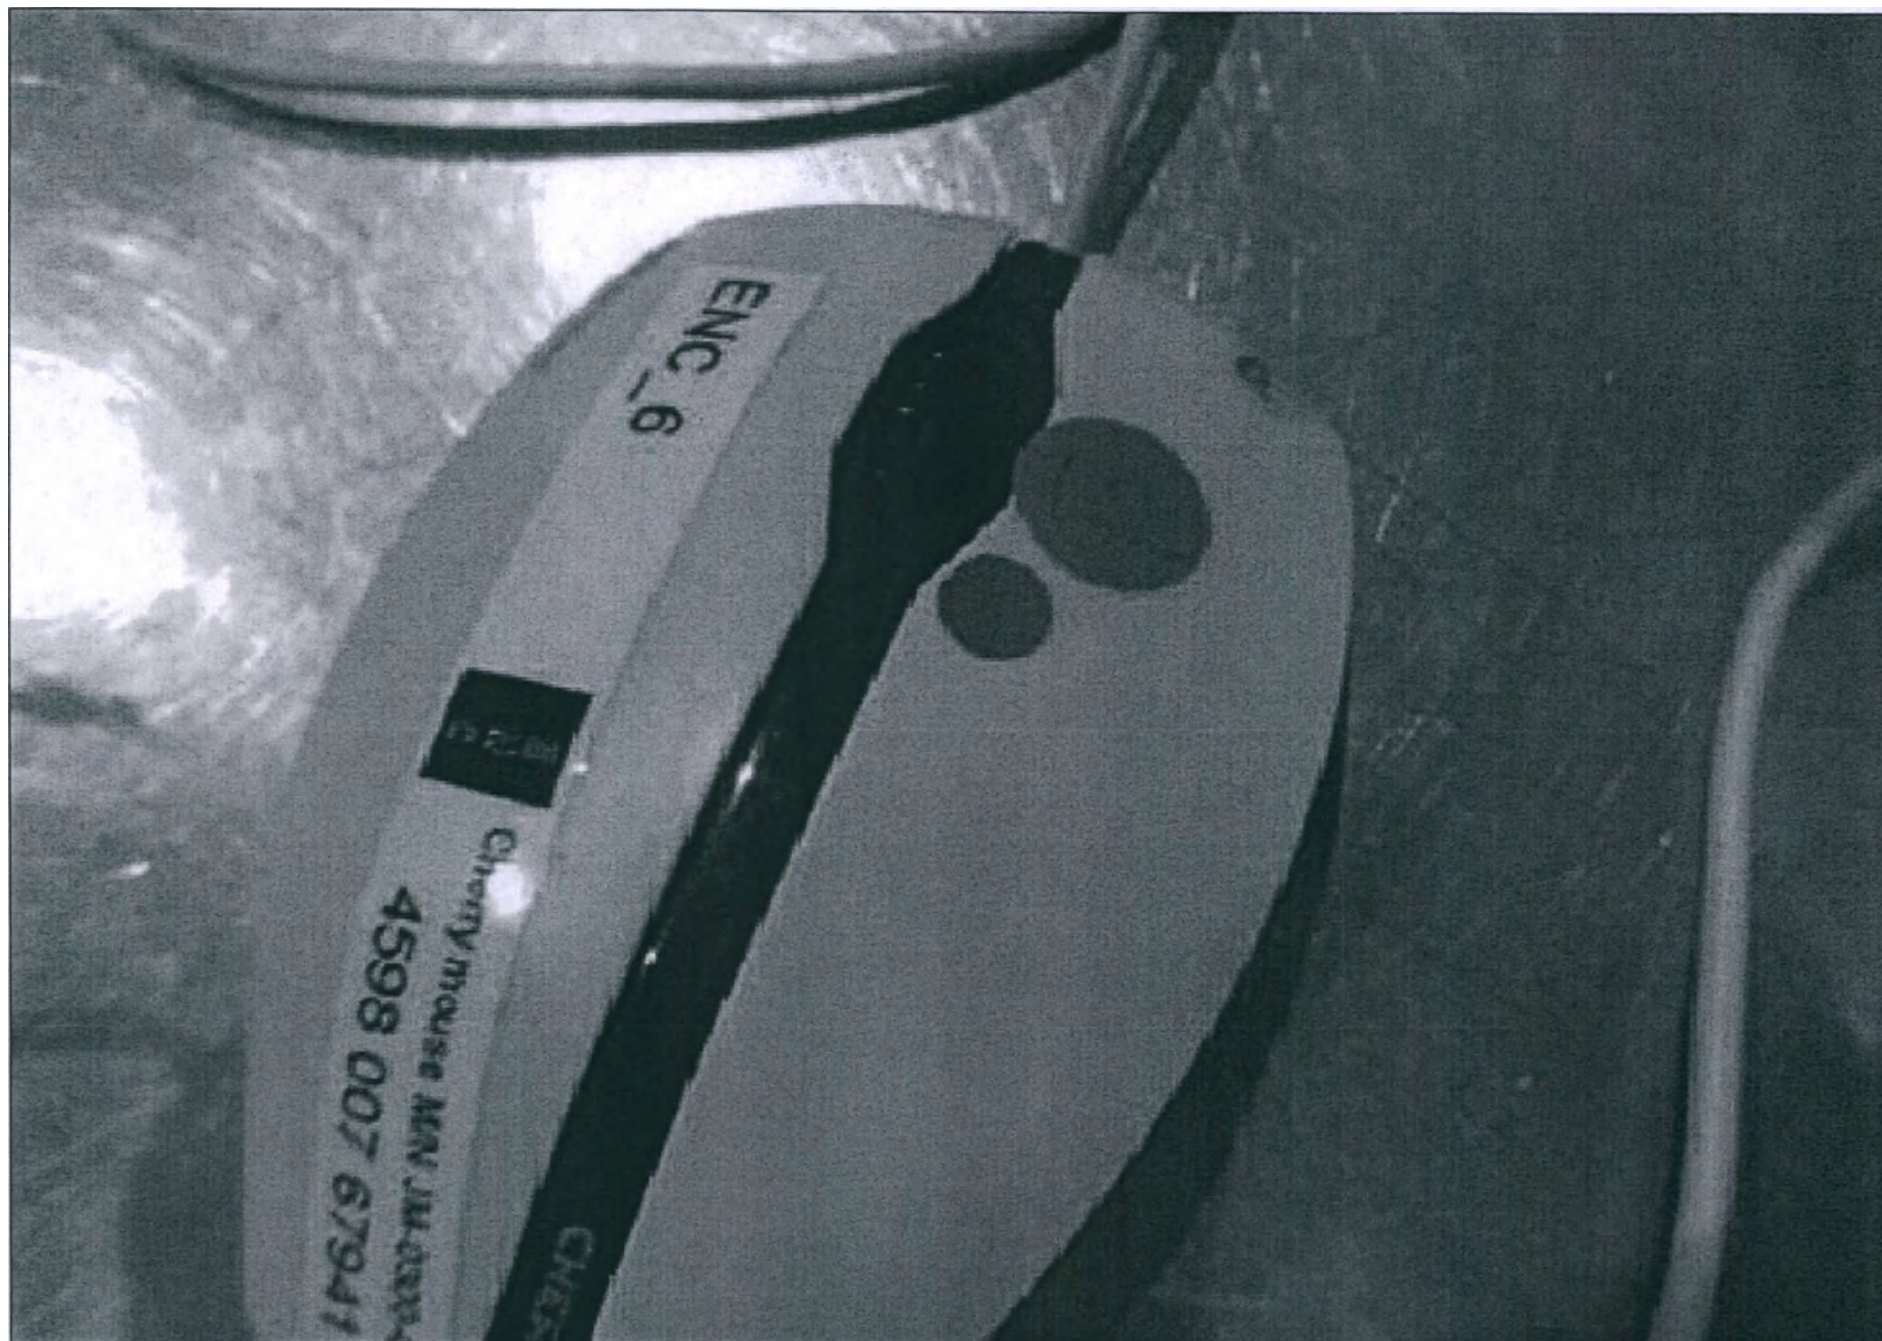


10.2. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

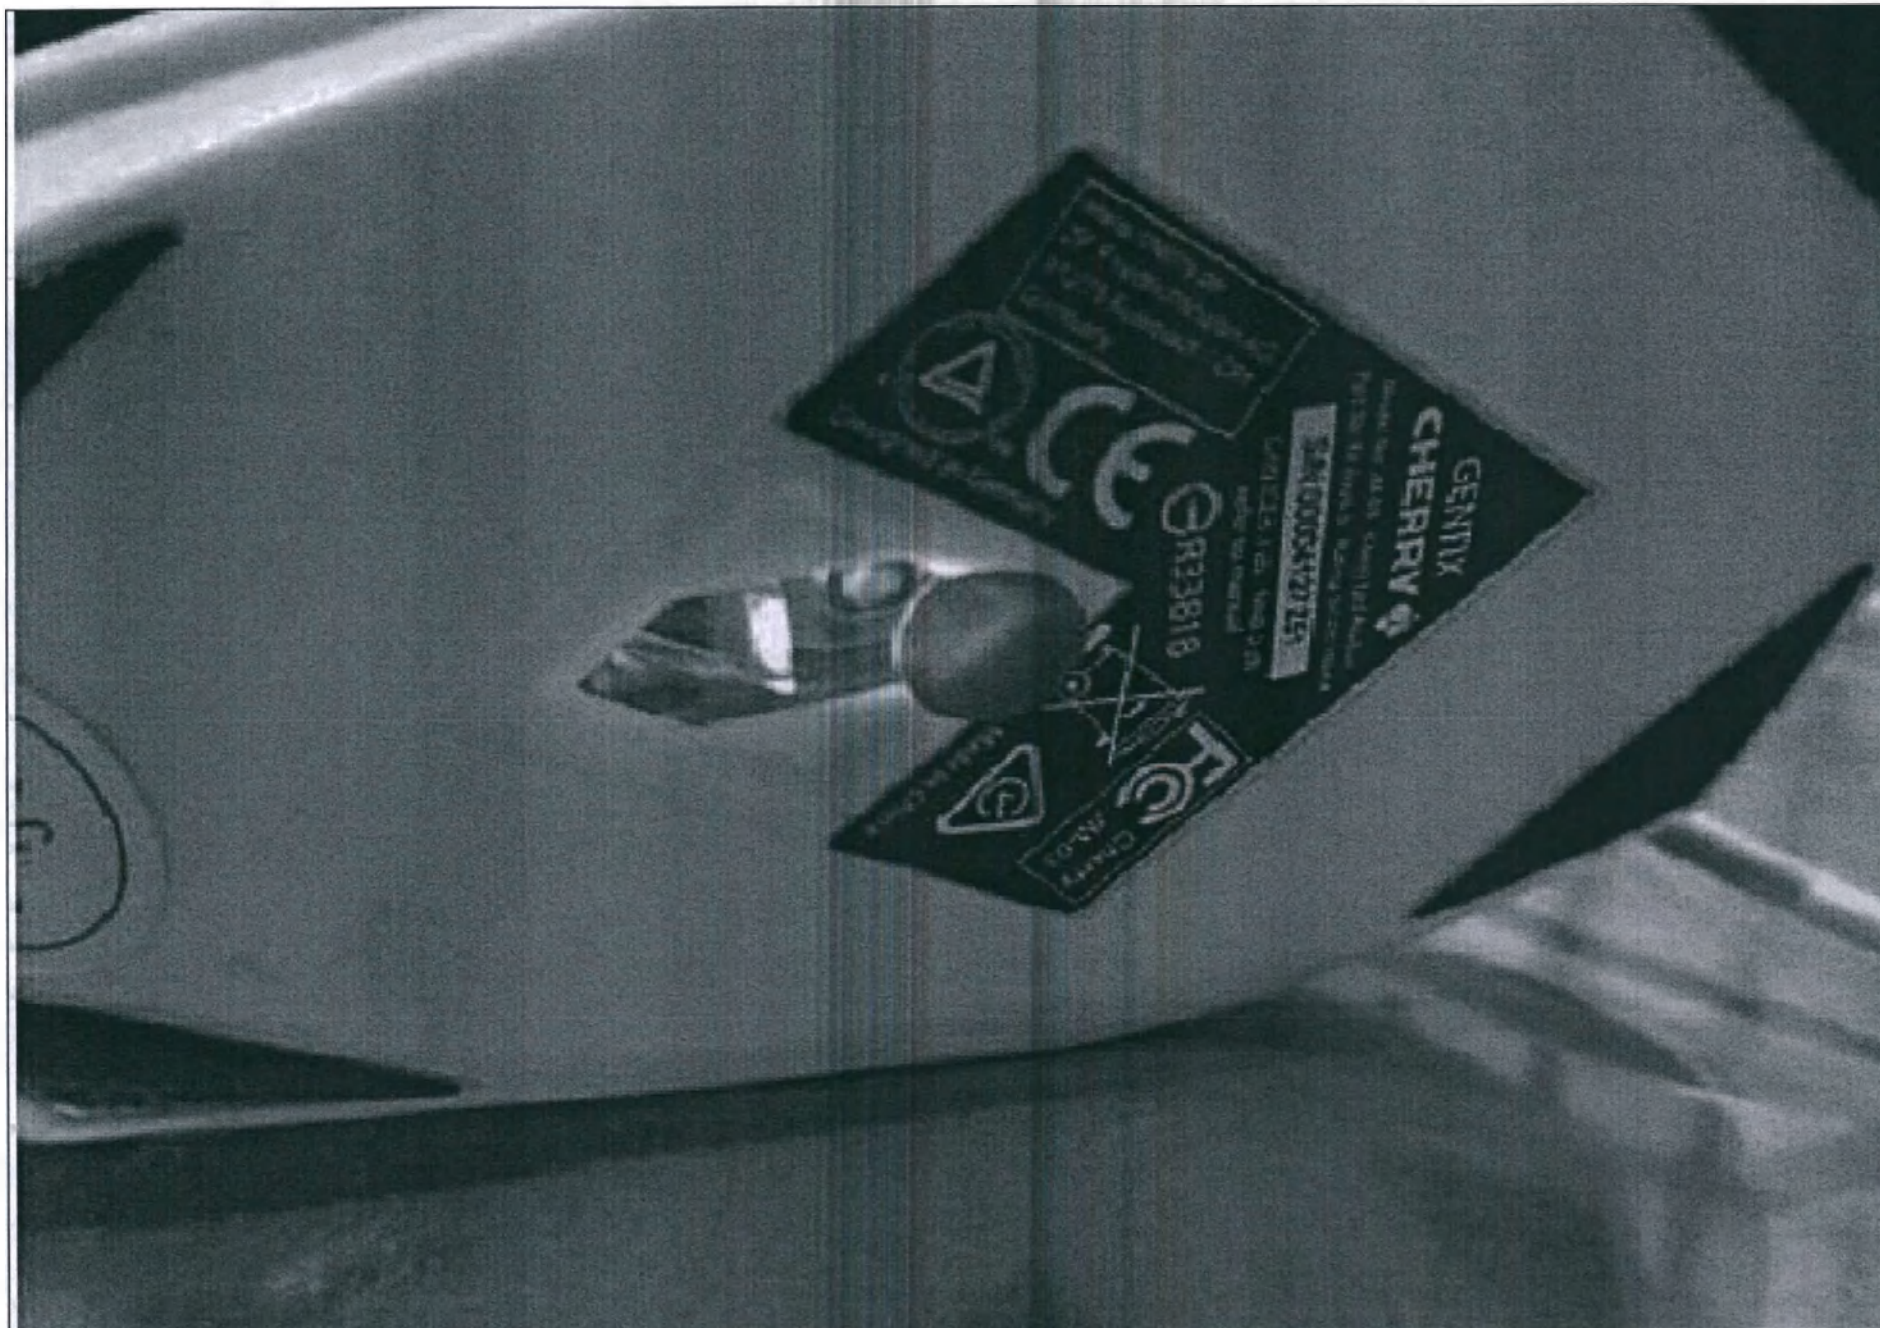


10.д. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; **Мышь**; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

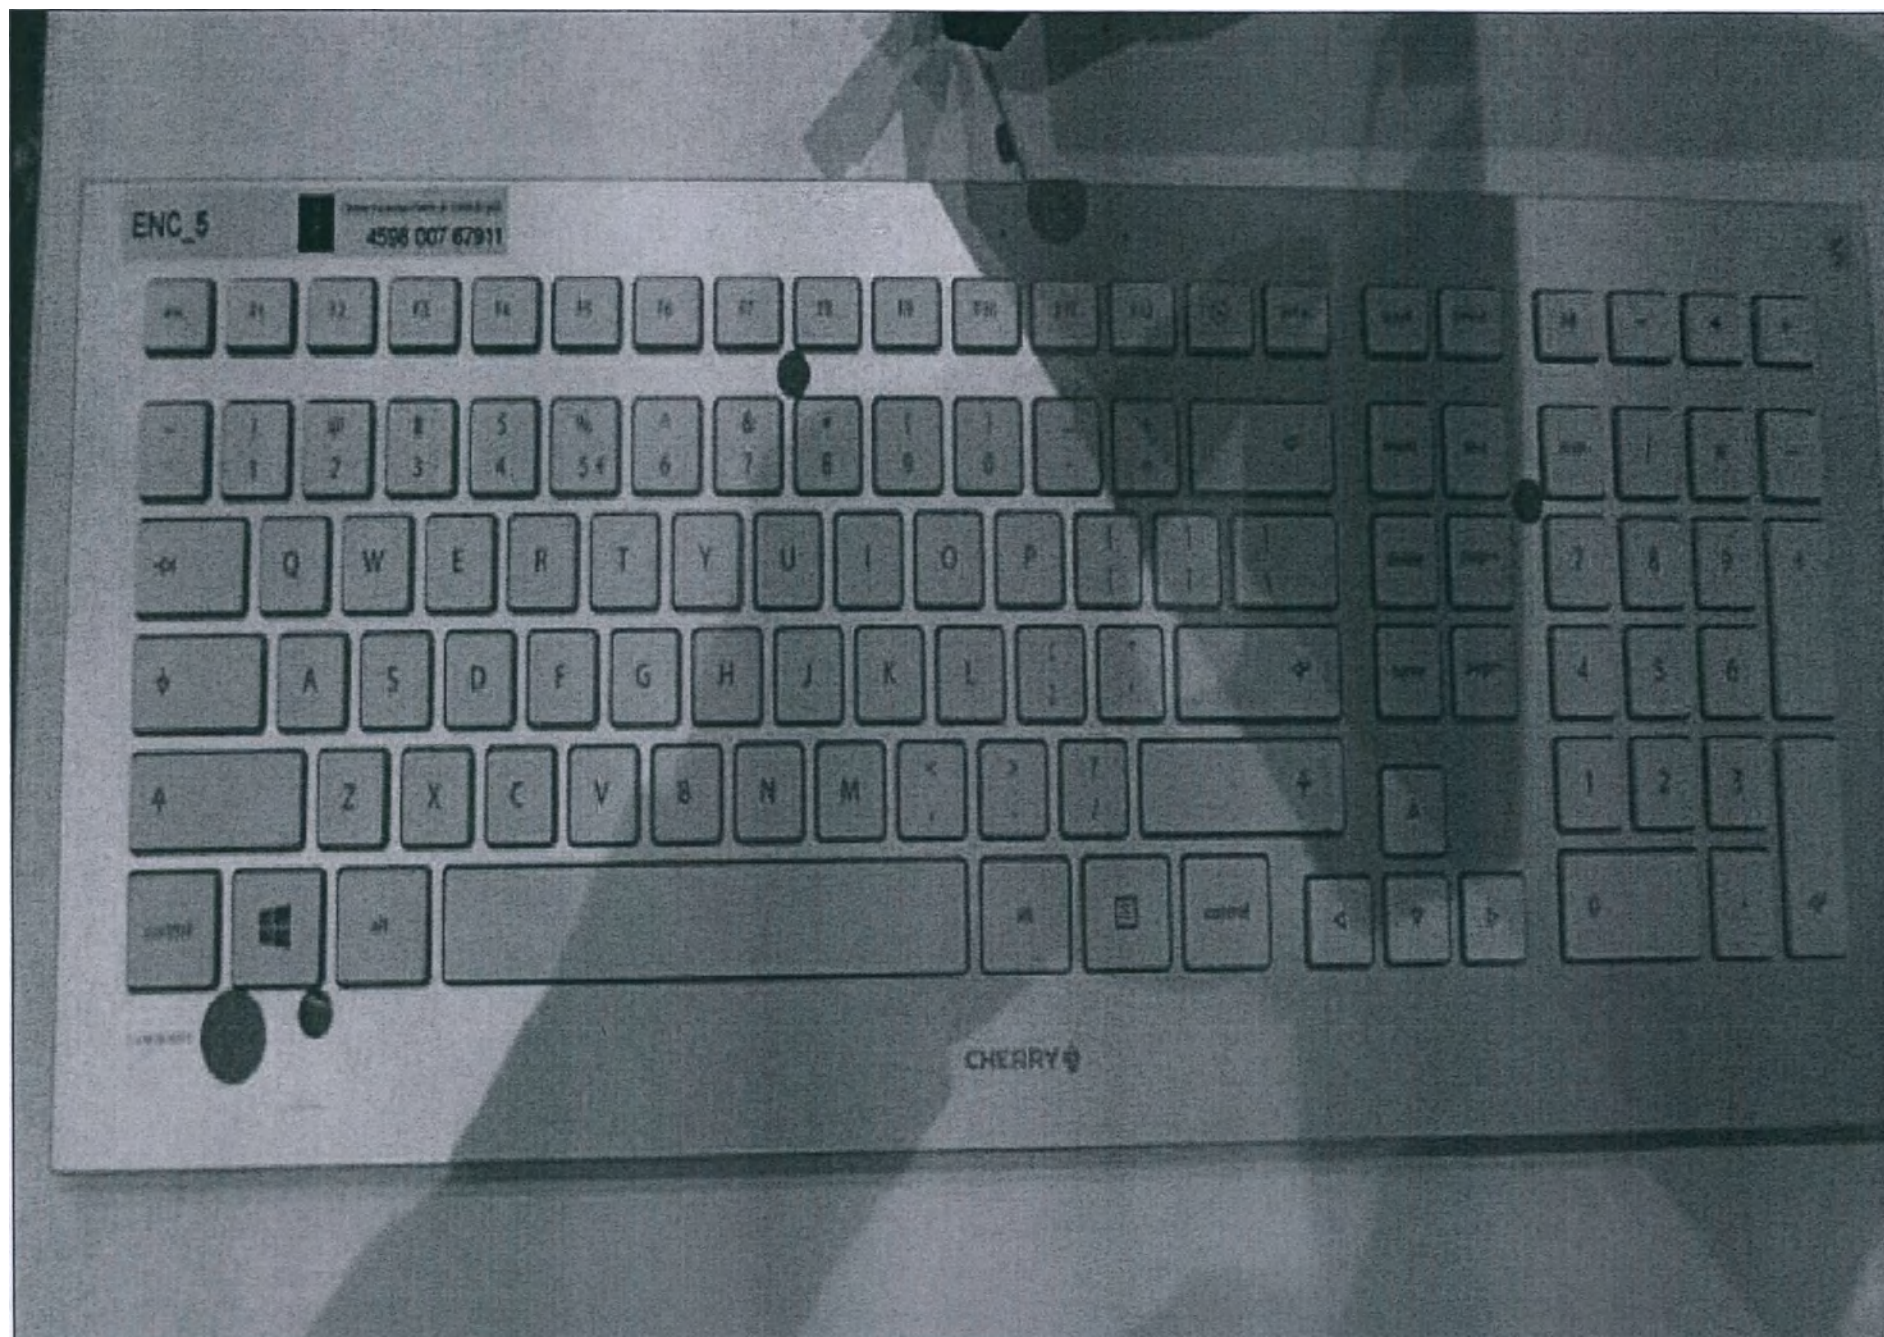


10.е. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

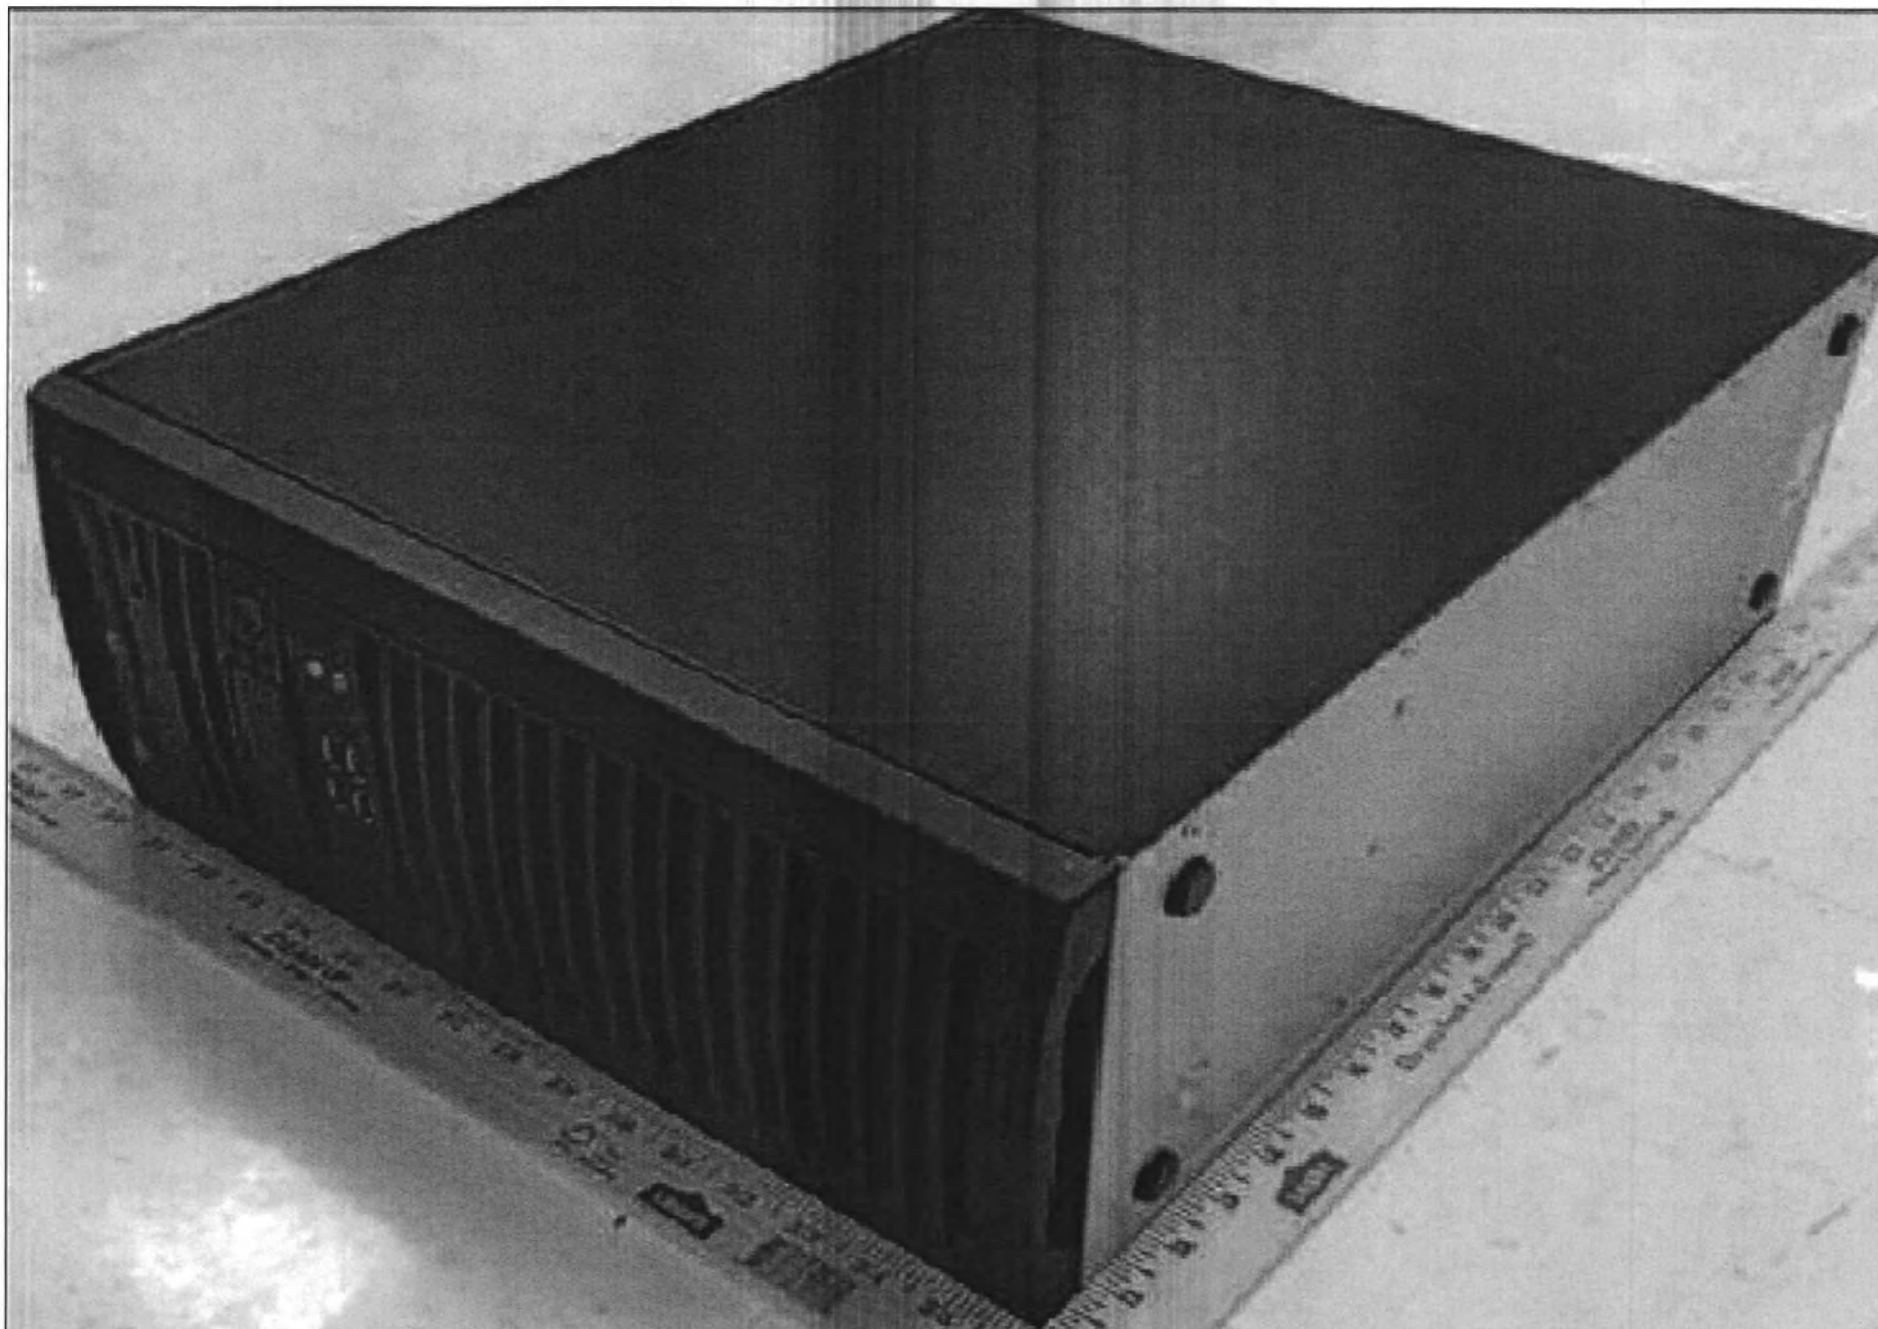

10.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

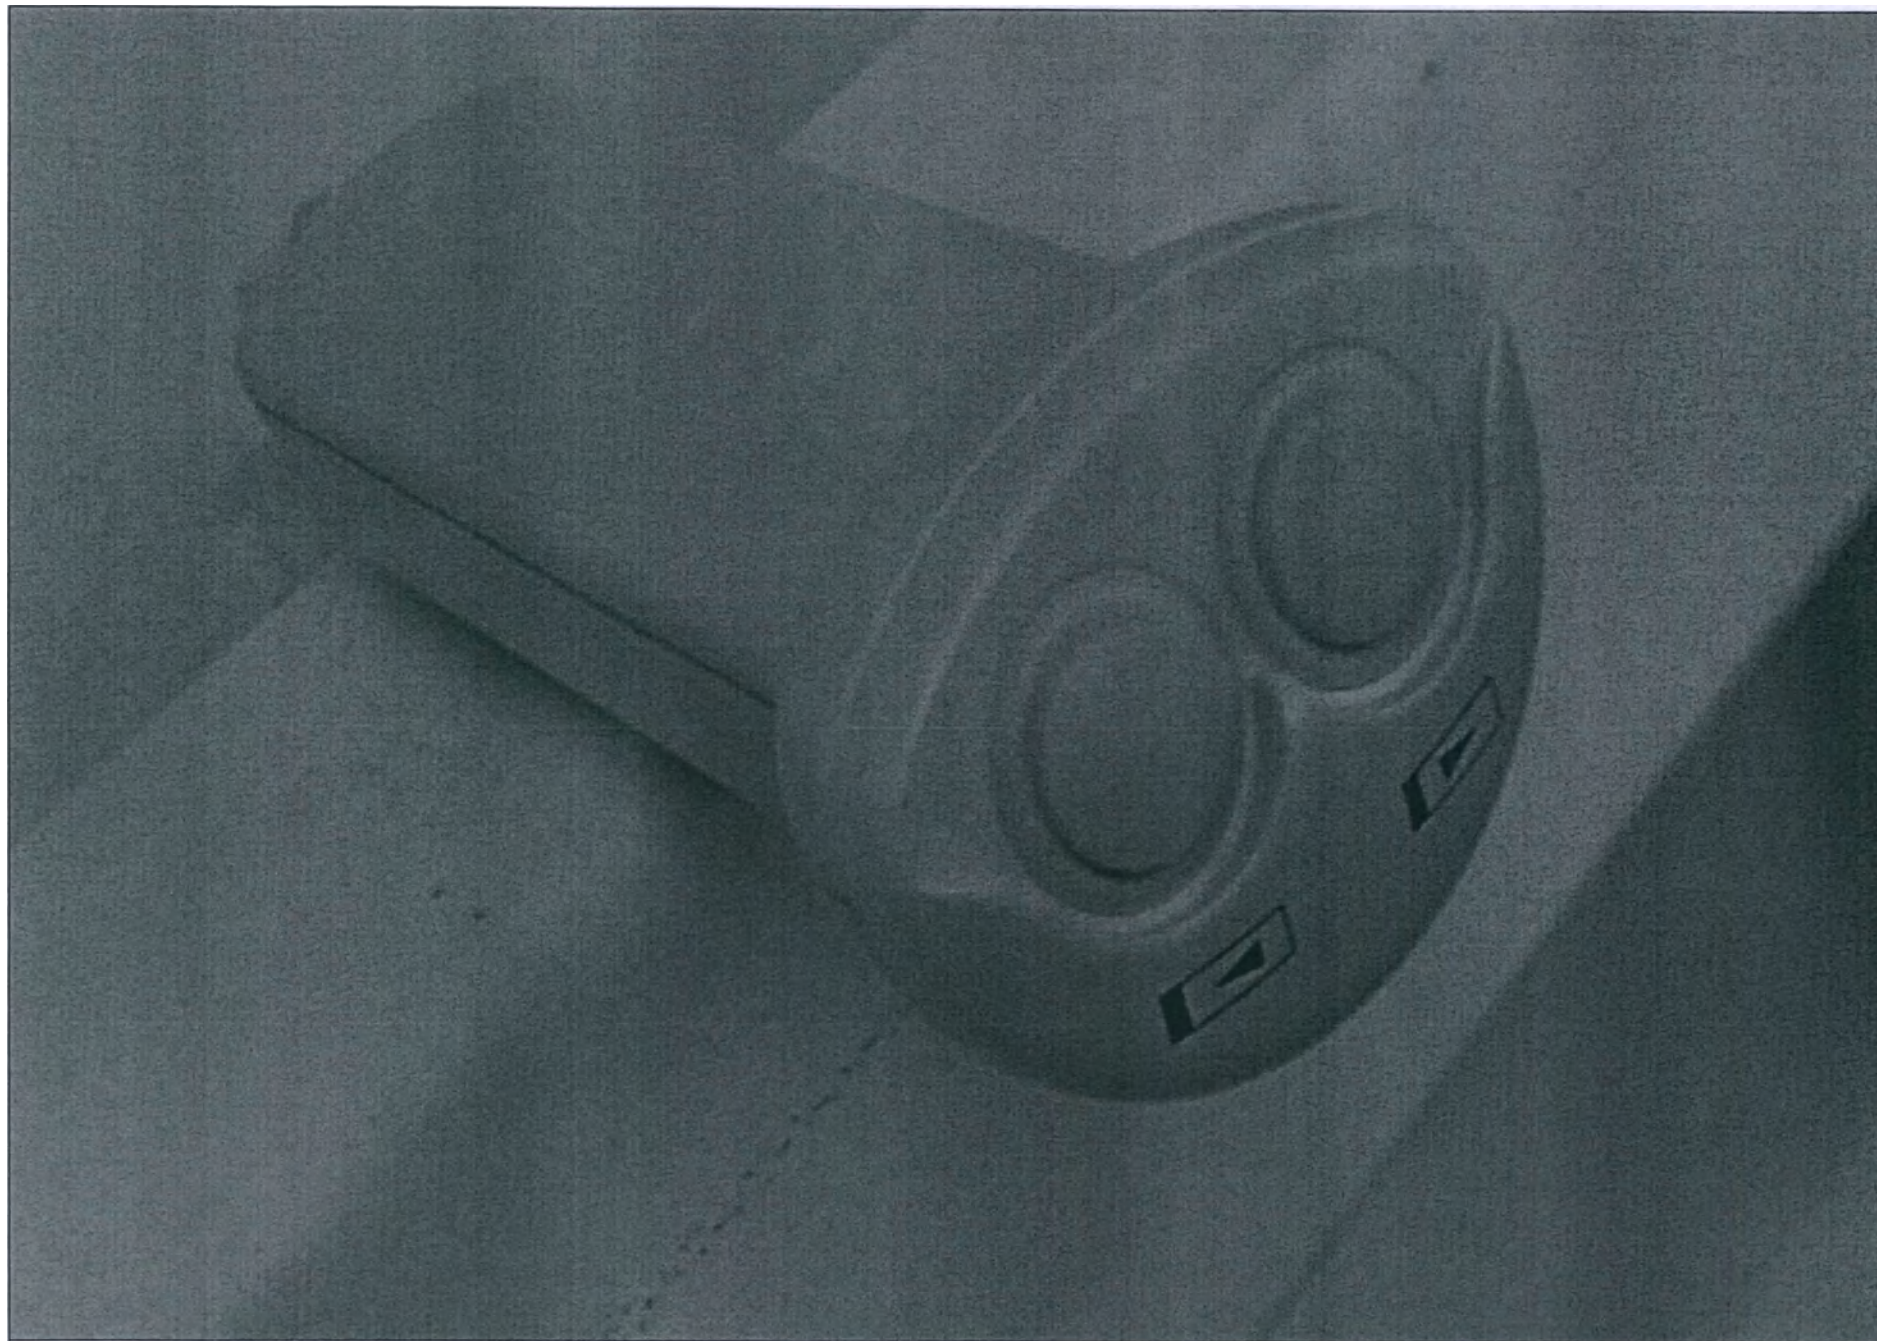


11. Ручной переключатель сдвига.

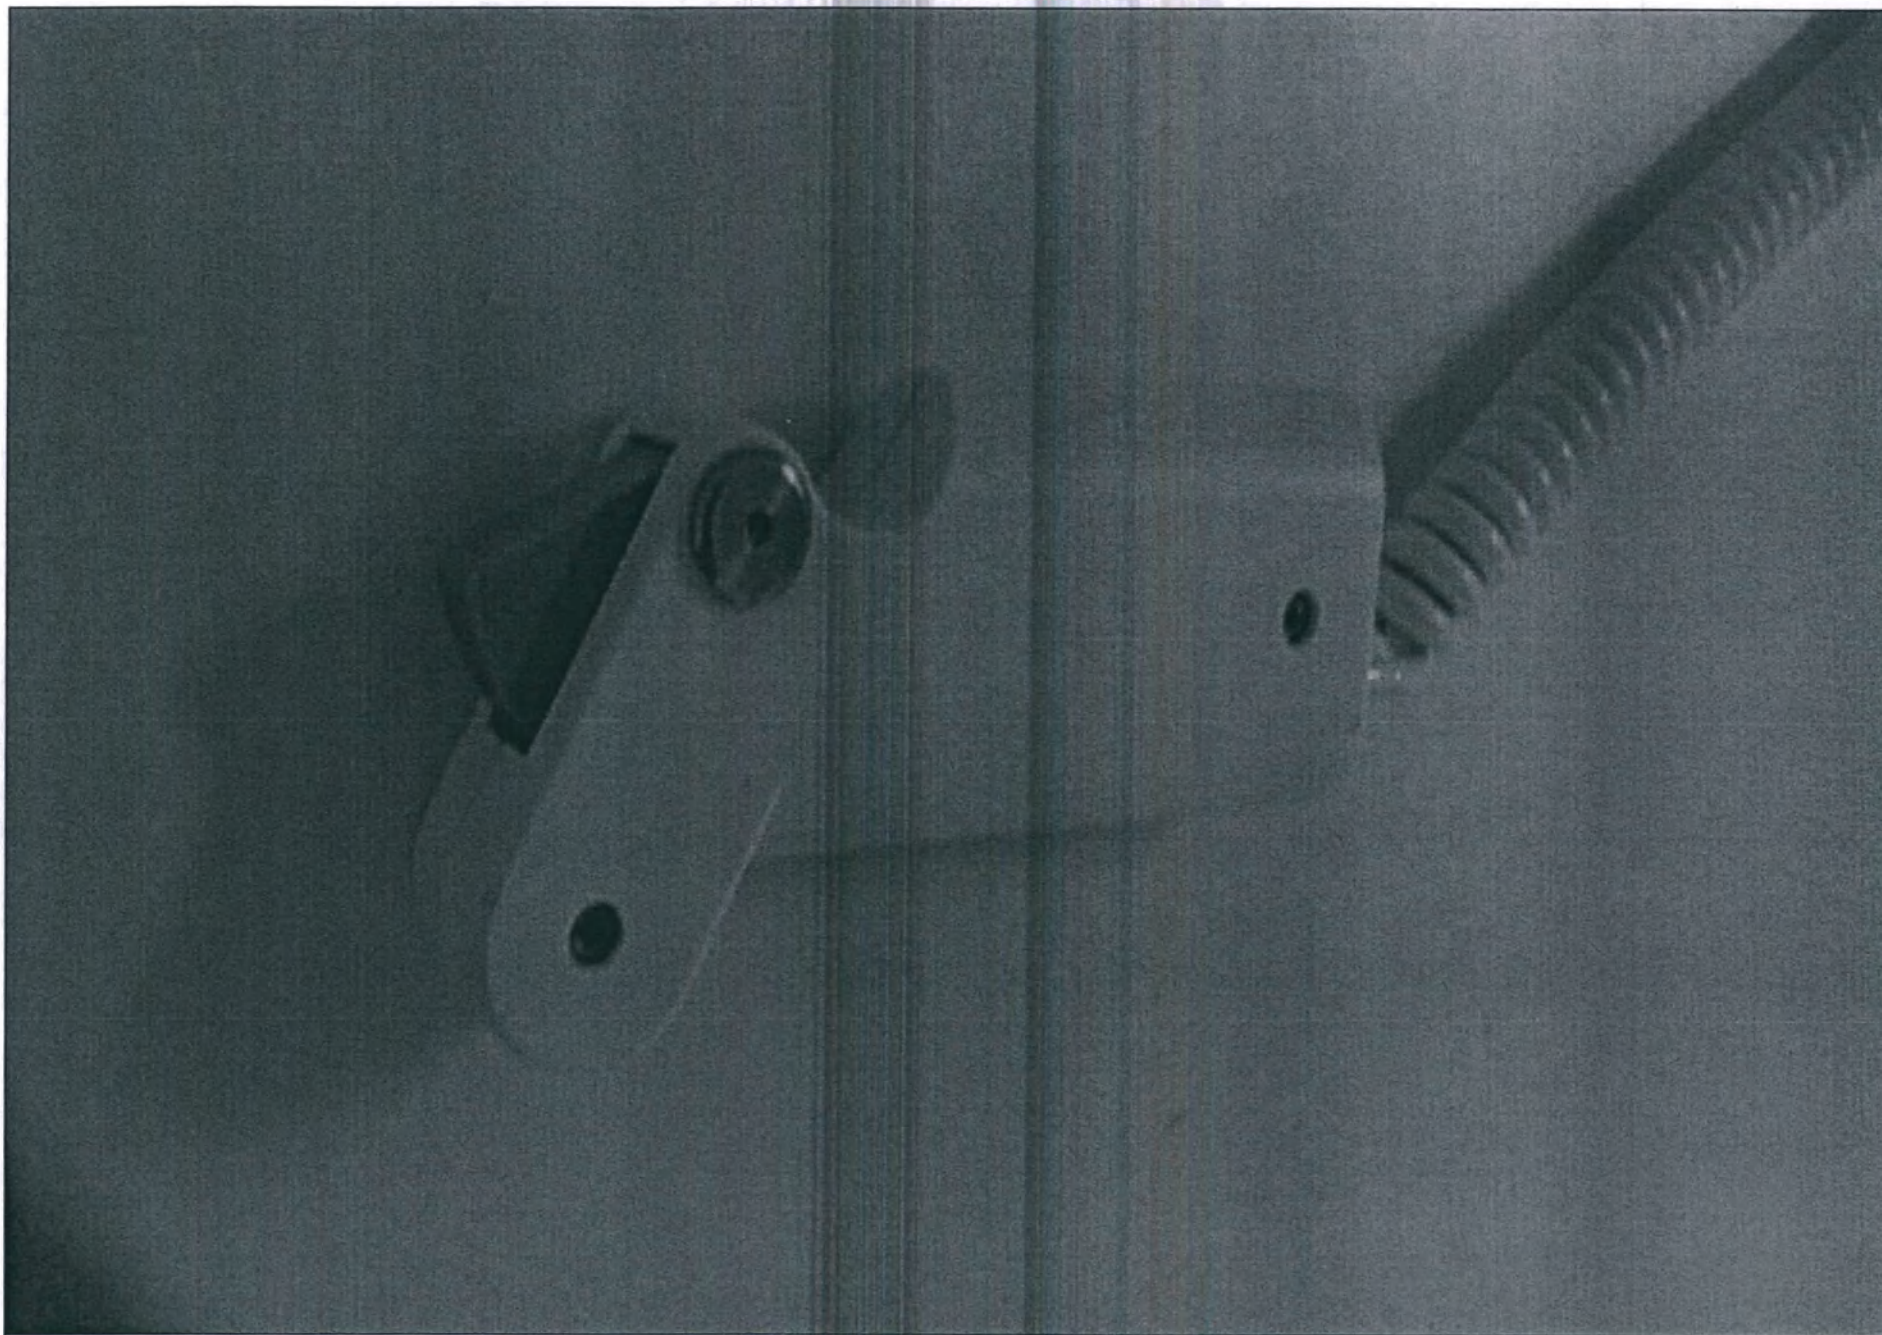


12. Регулятор скорости.




13. Ручной переключатель экспозиции.

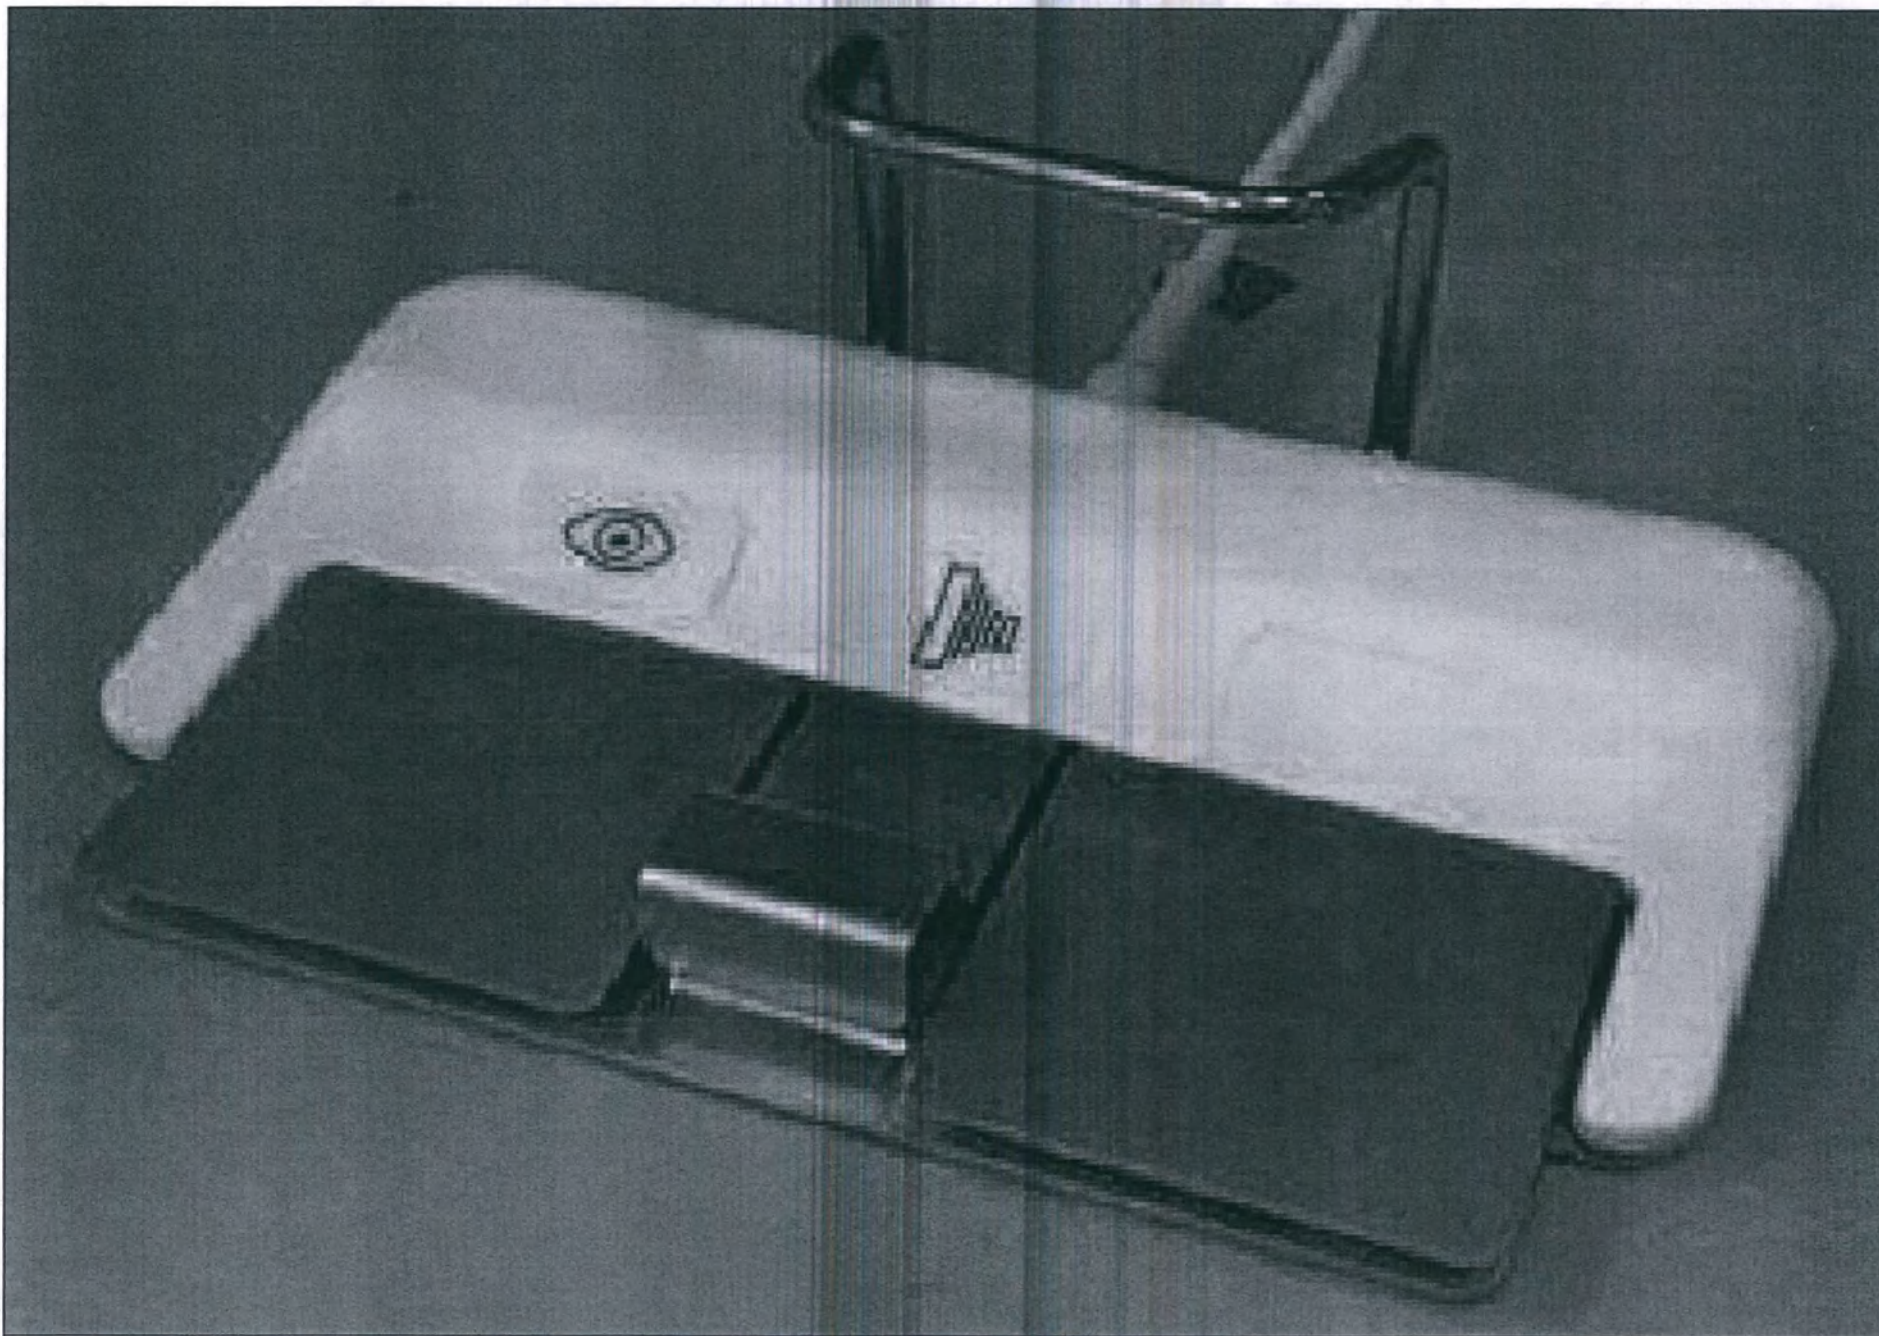


14. Ножной переключатель, не более 2 шт.

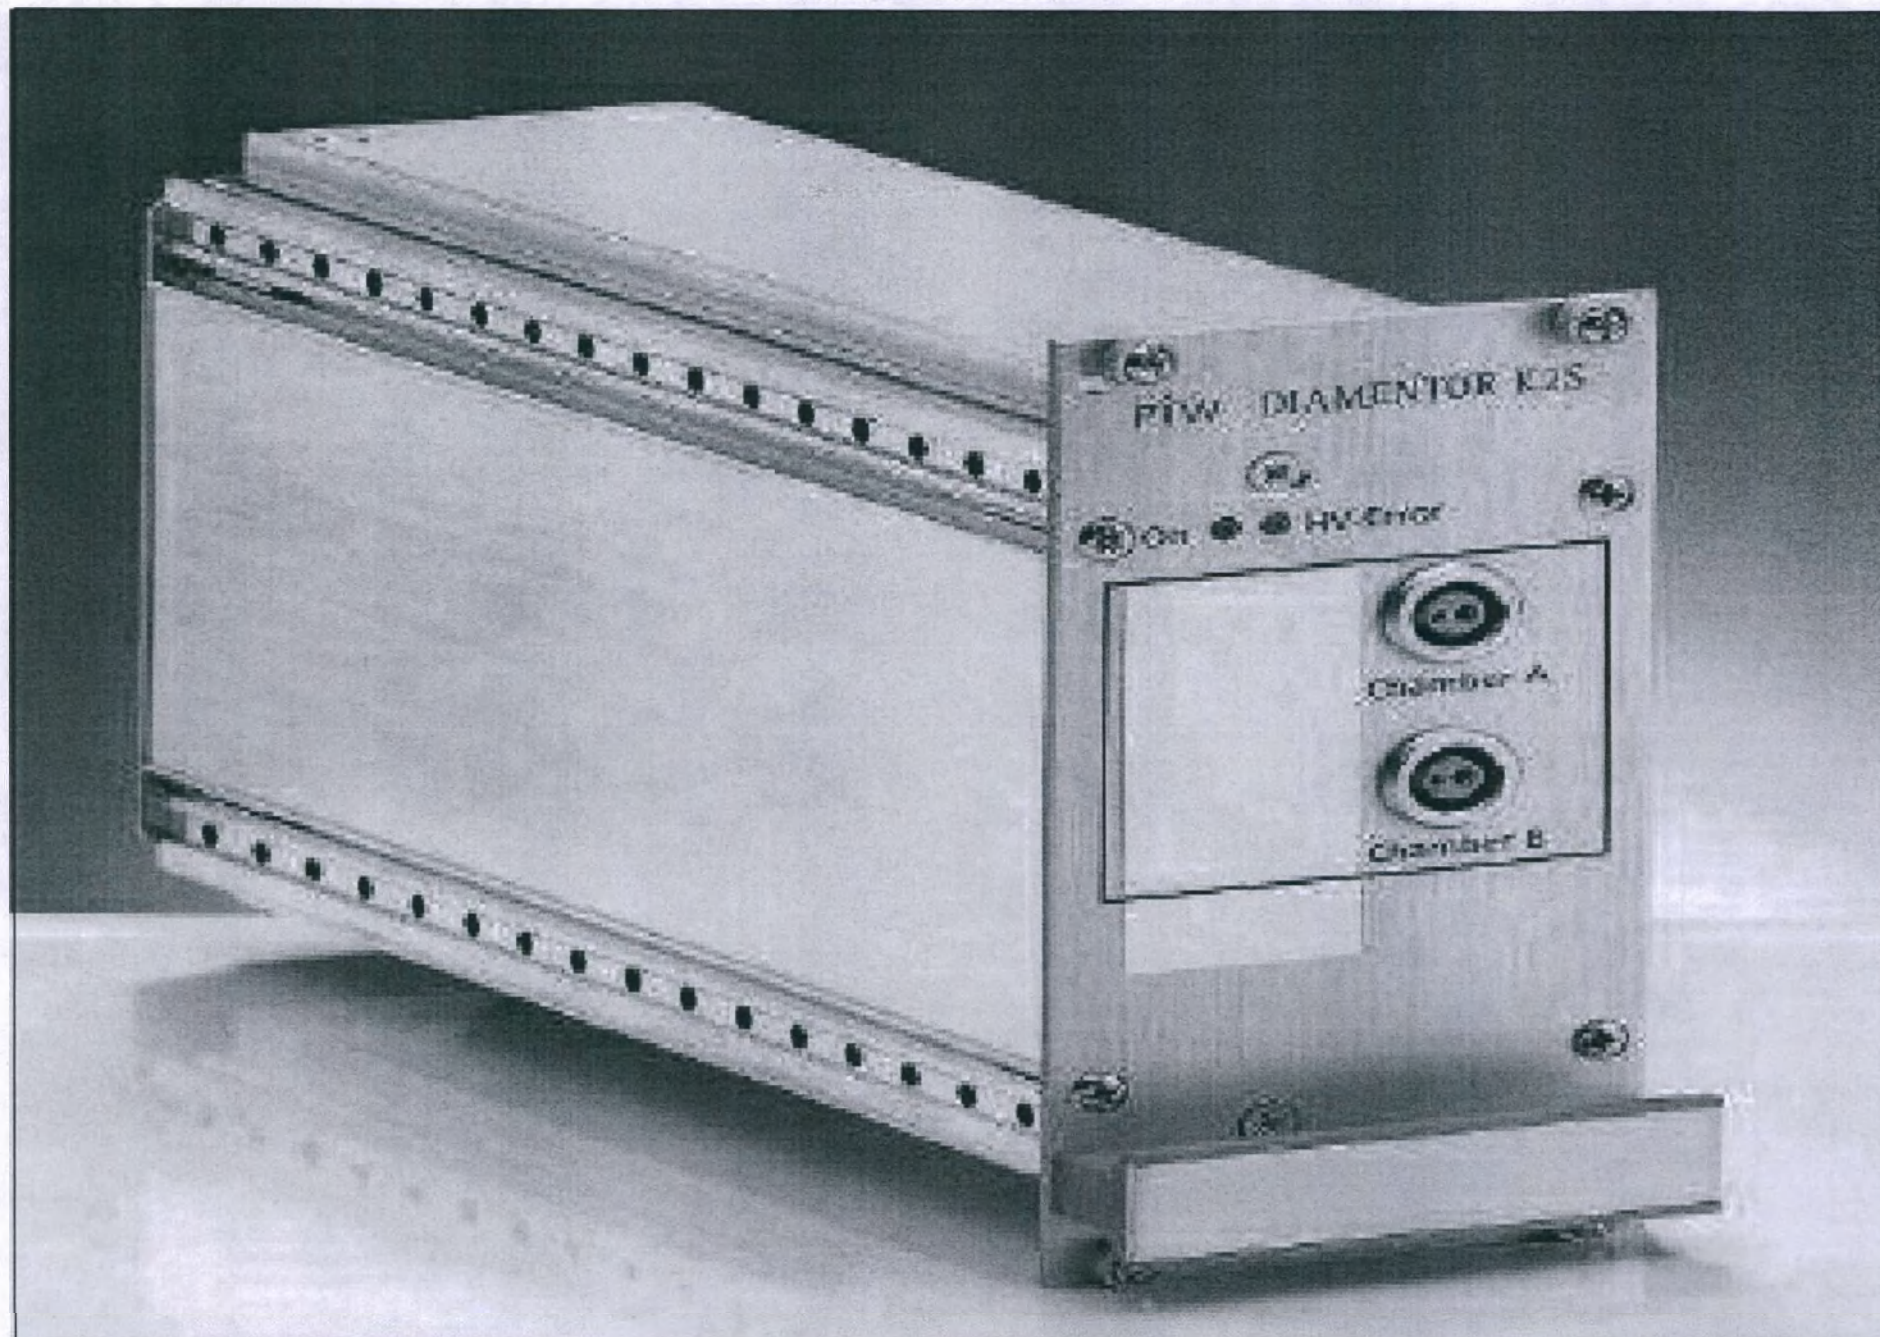


15.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

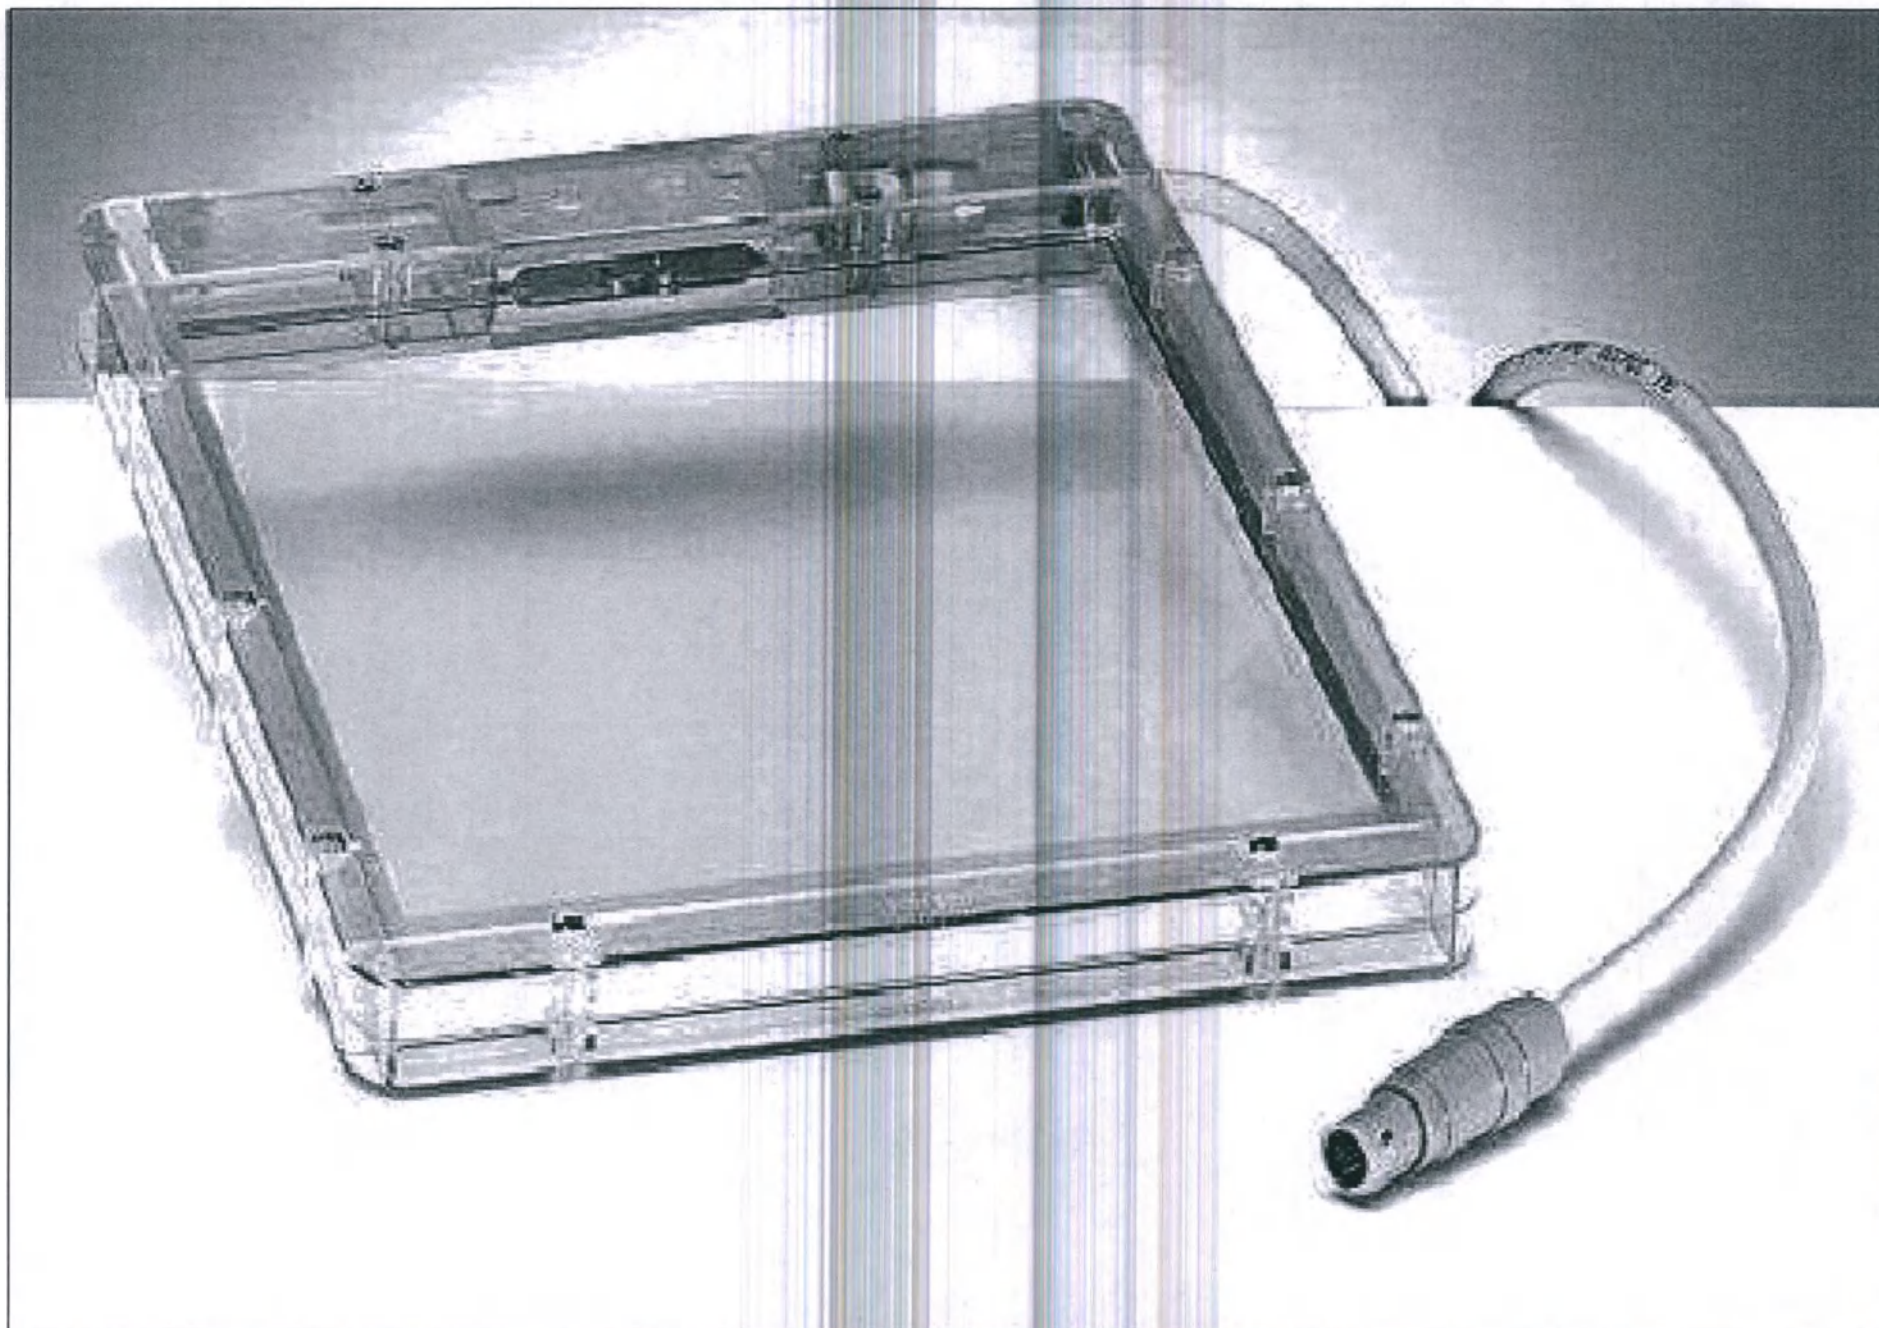


15.6. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

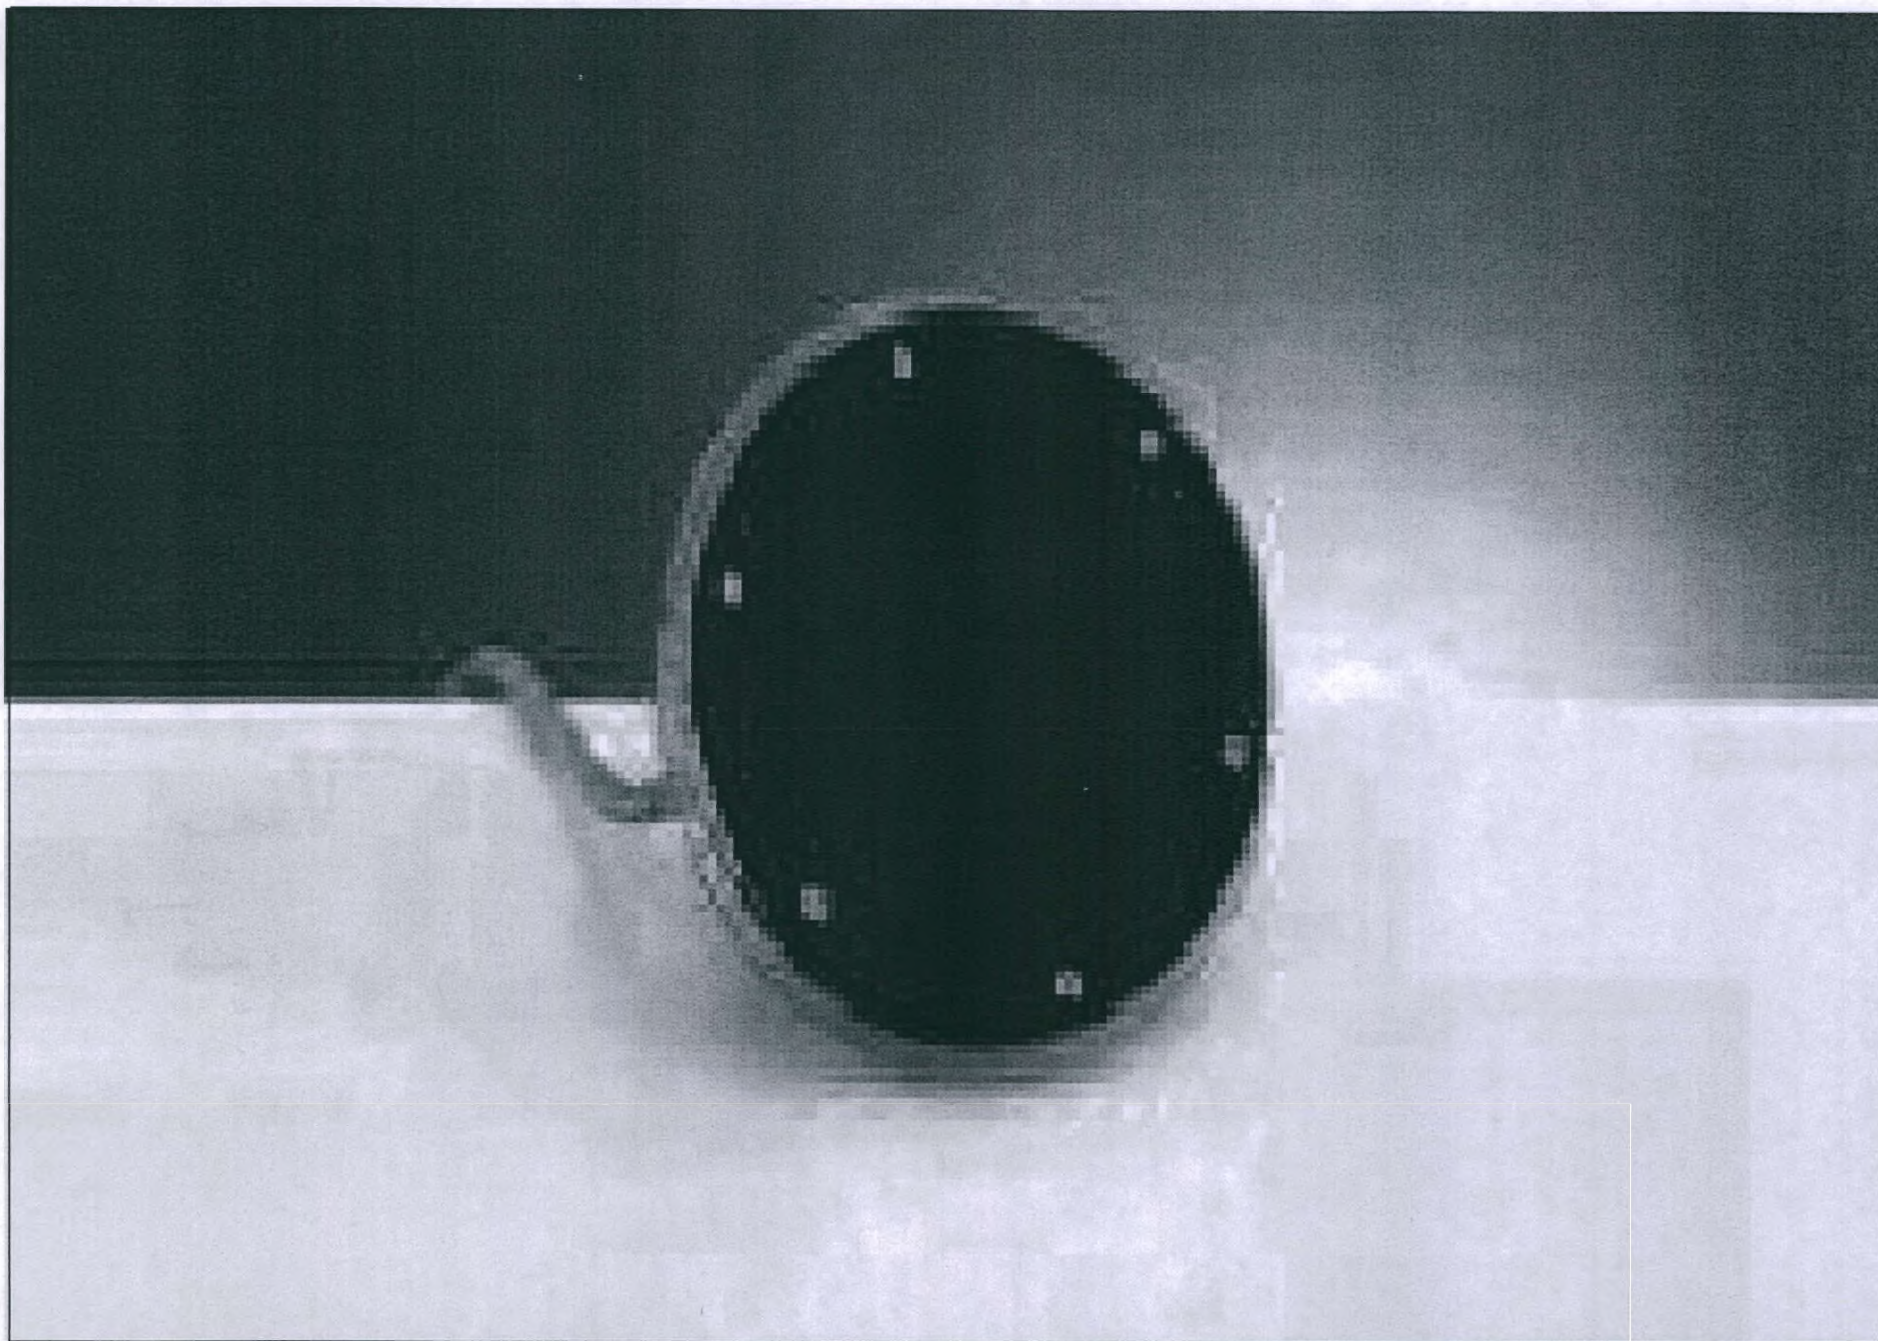


15.в. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

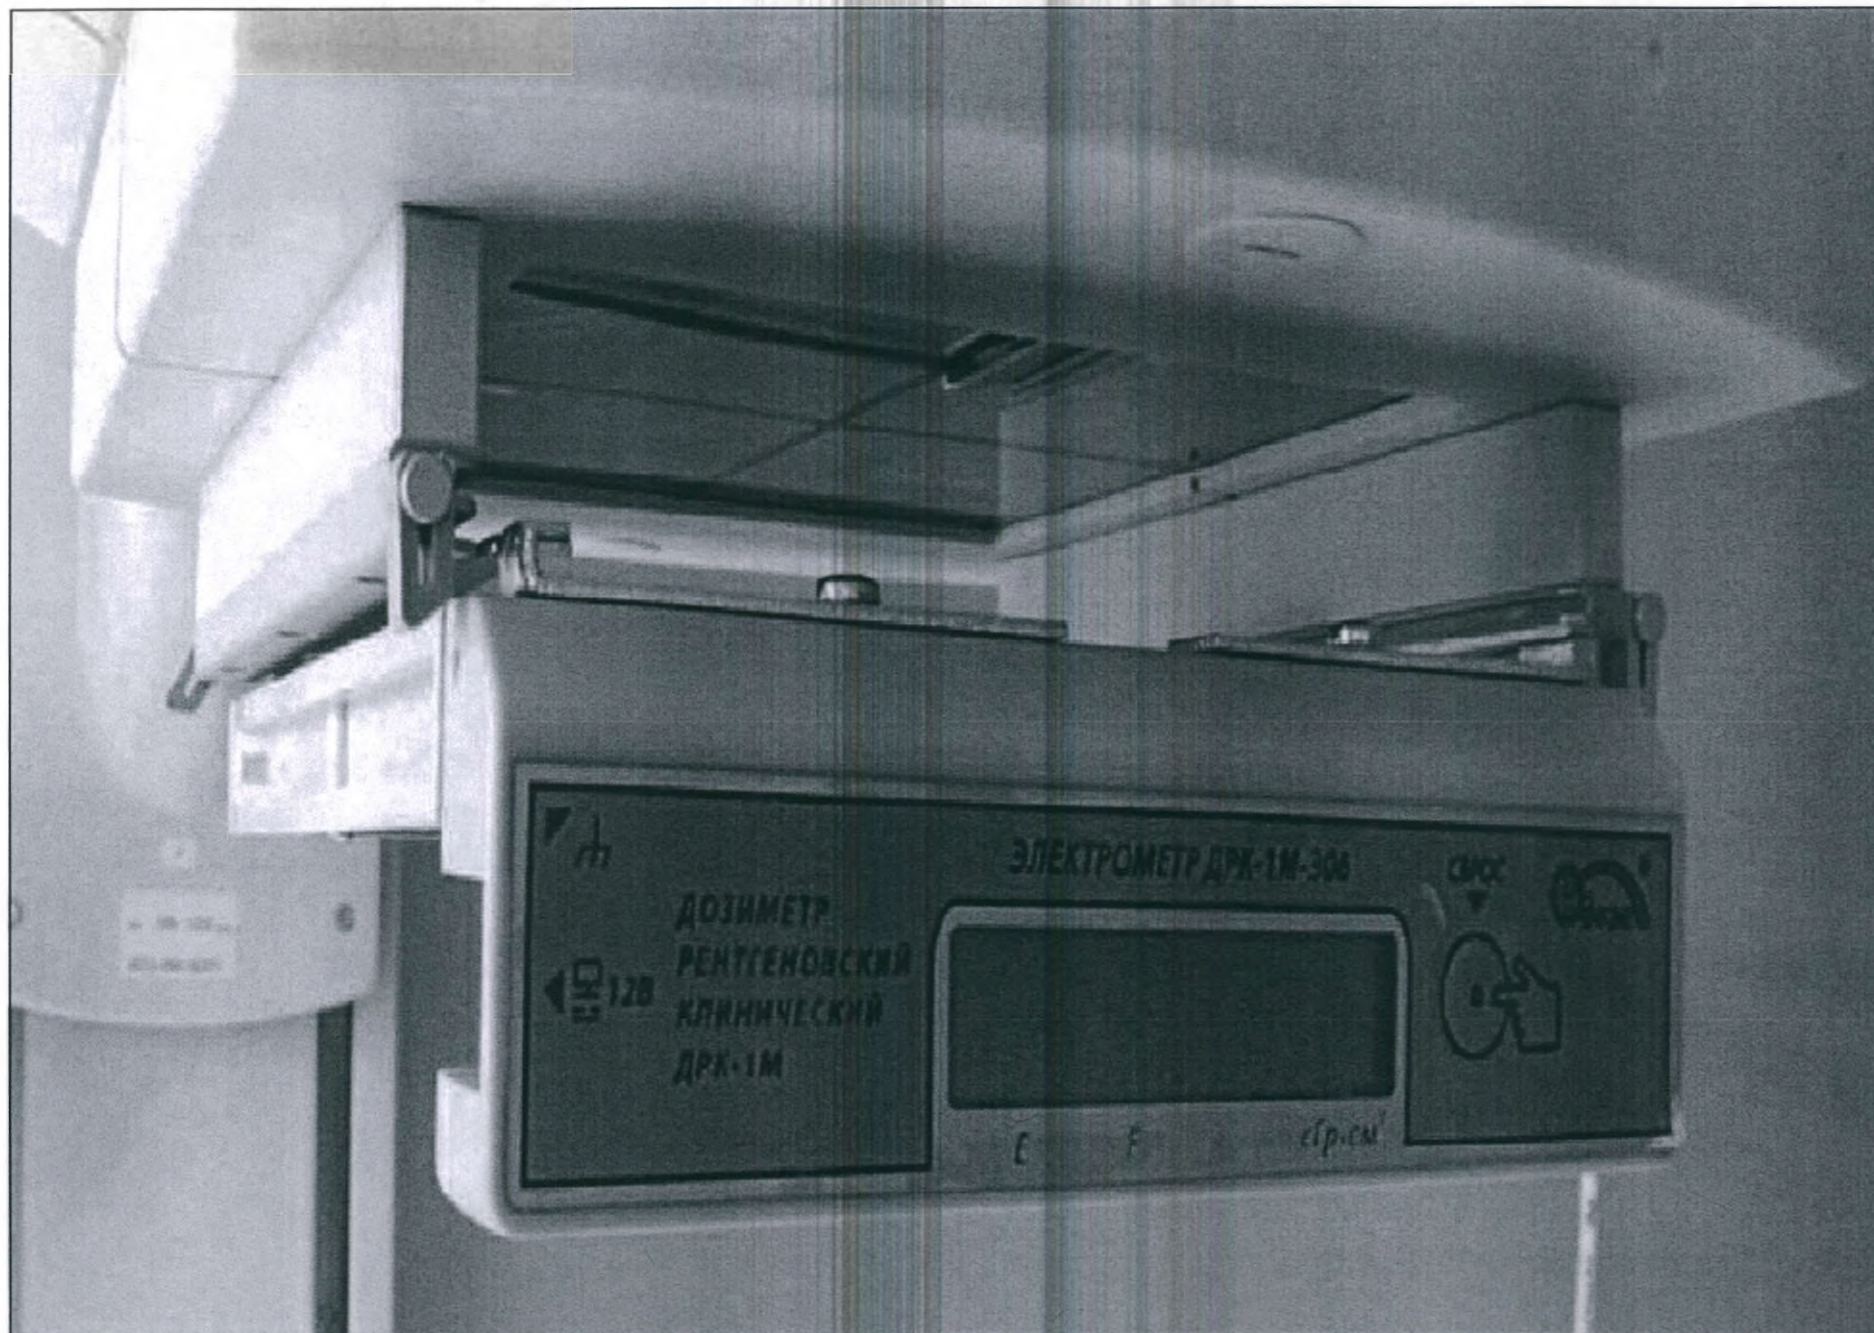


15.г. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или DPR-1 или DPR-1M.

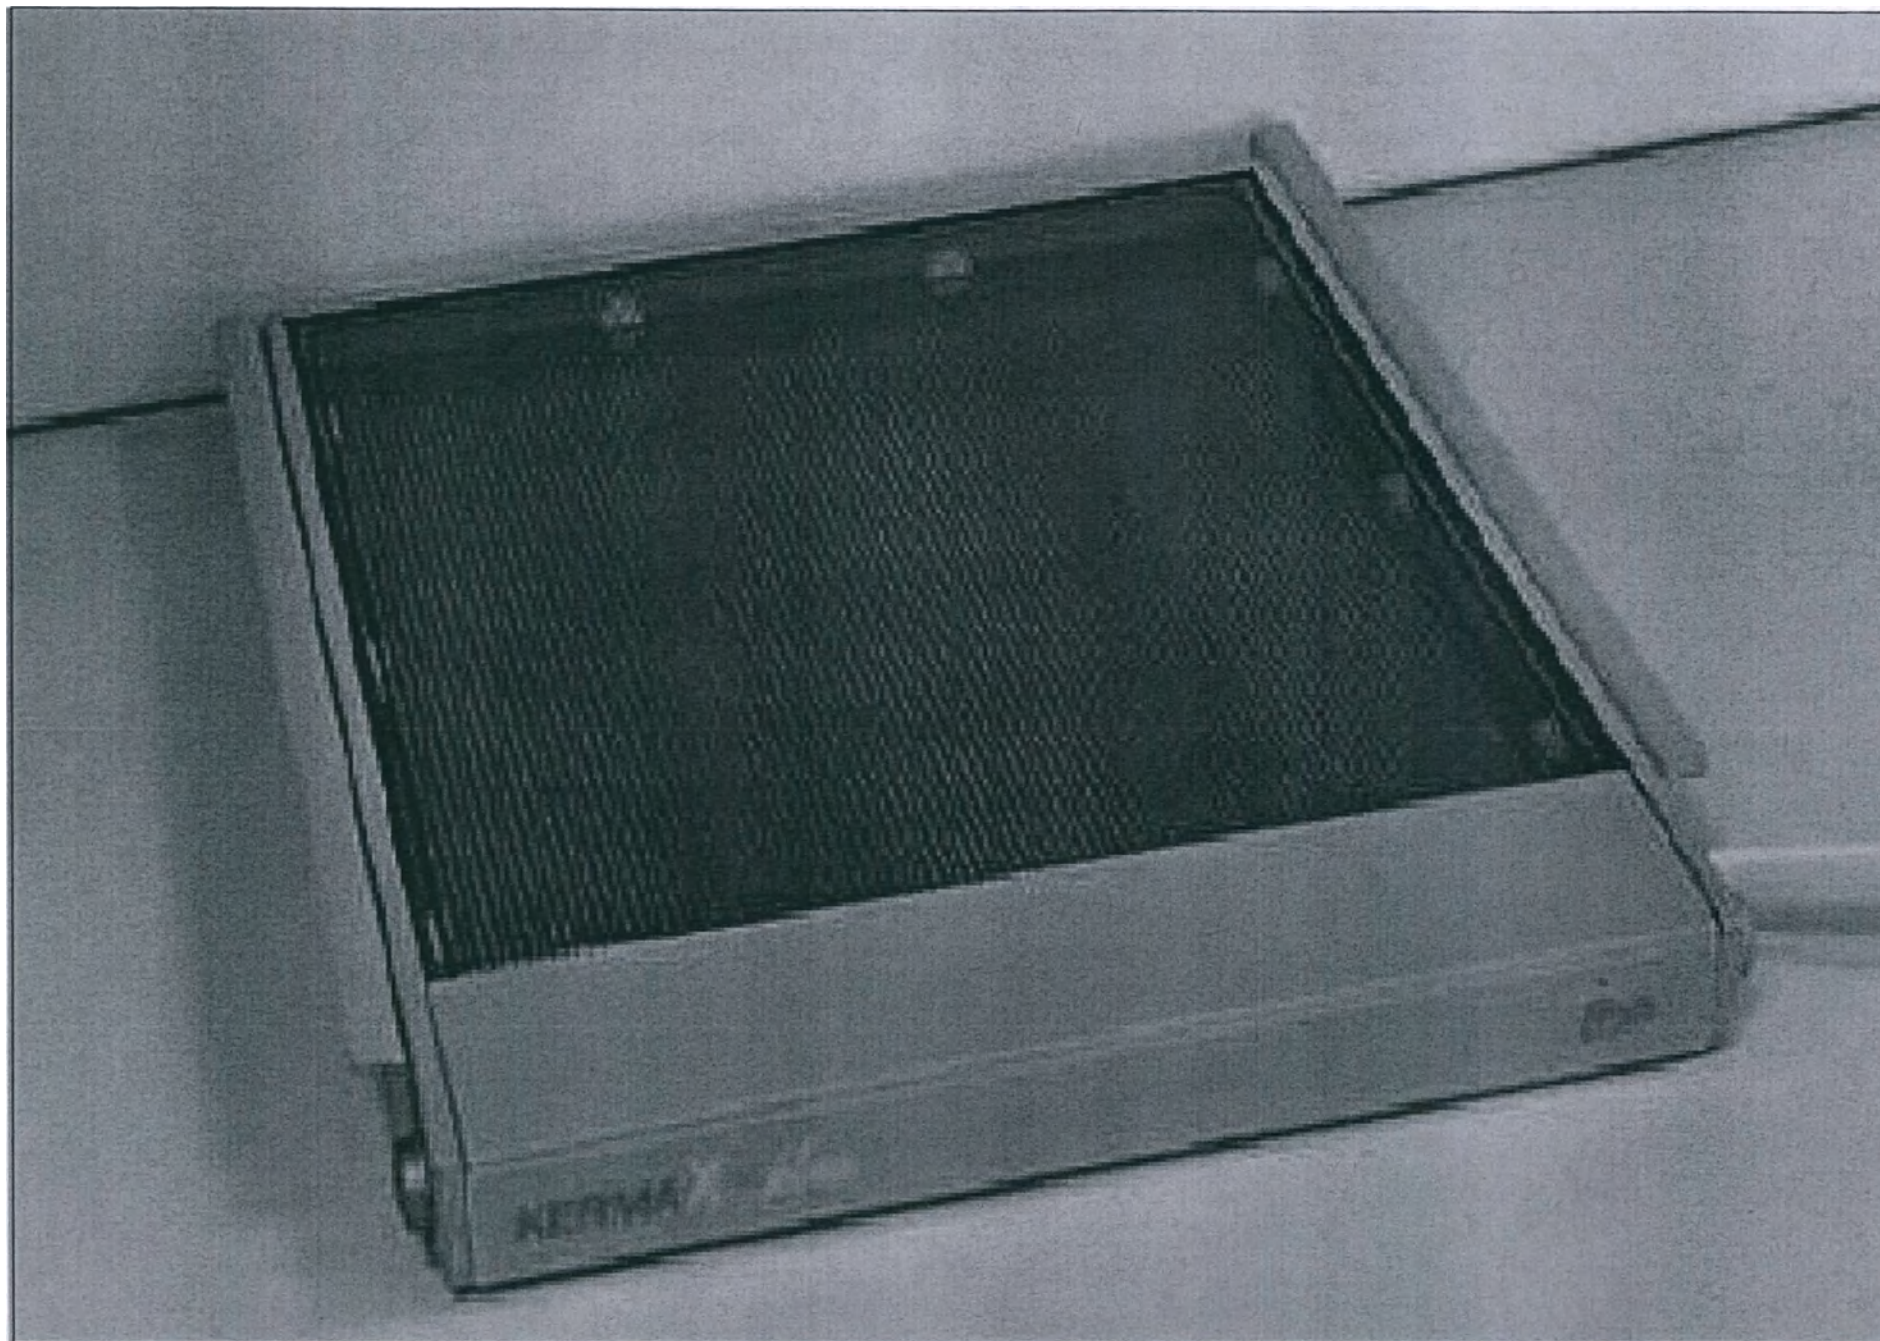


16. Измеритель производства дозы на площадь KermaX plus 120-132.

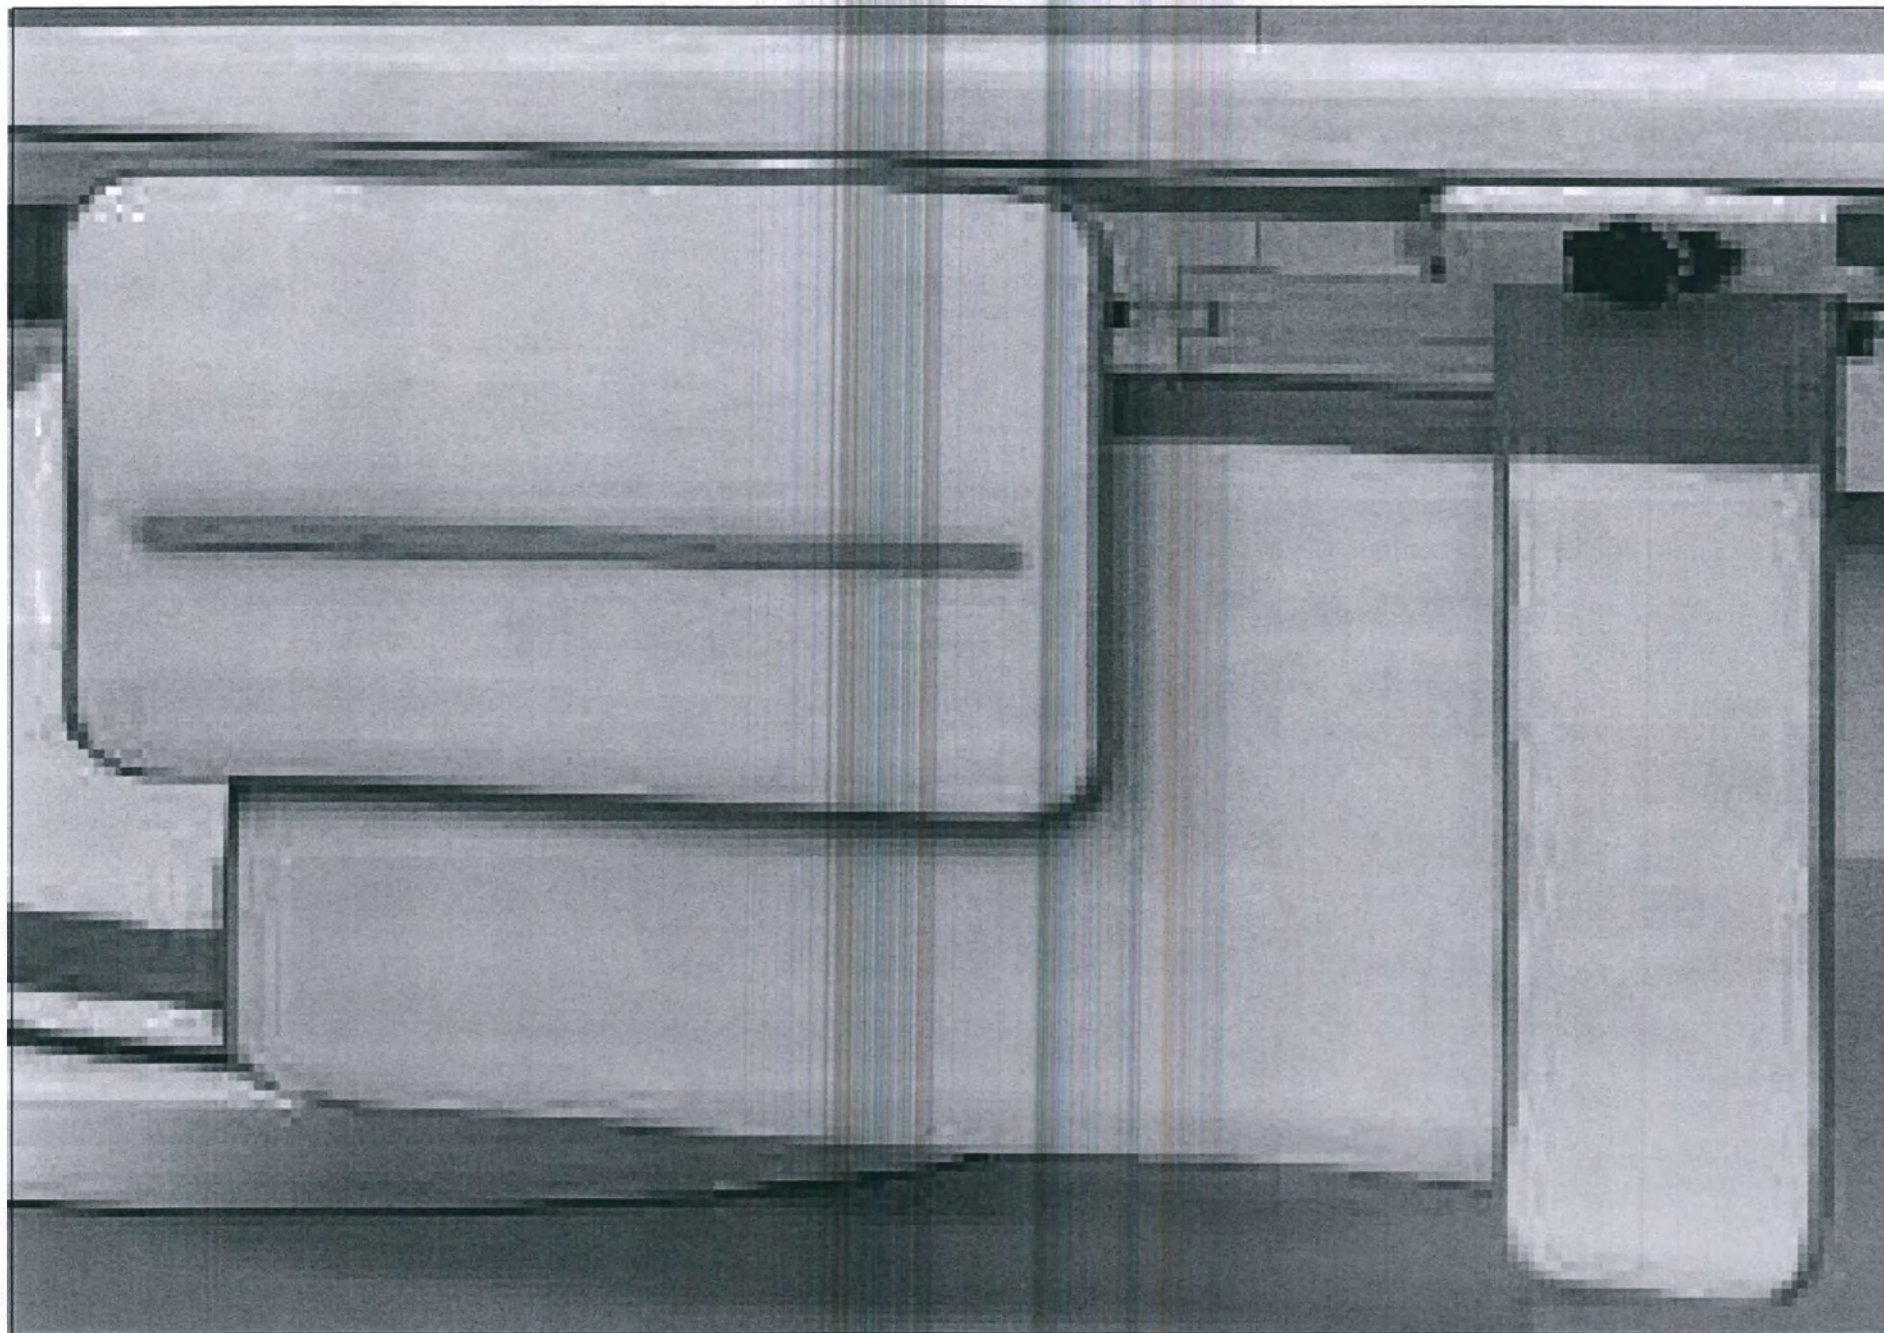


17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

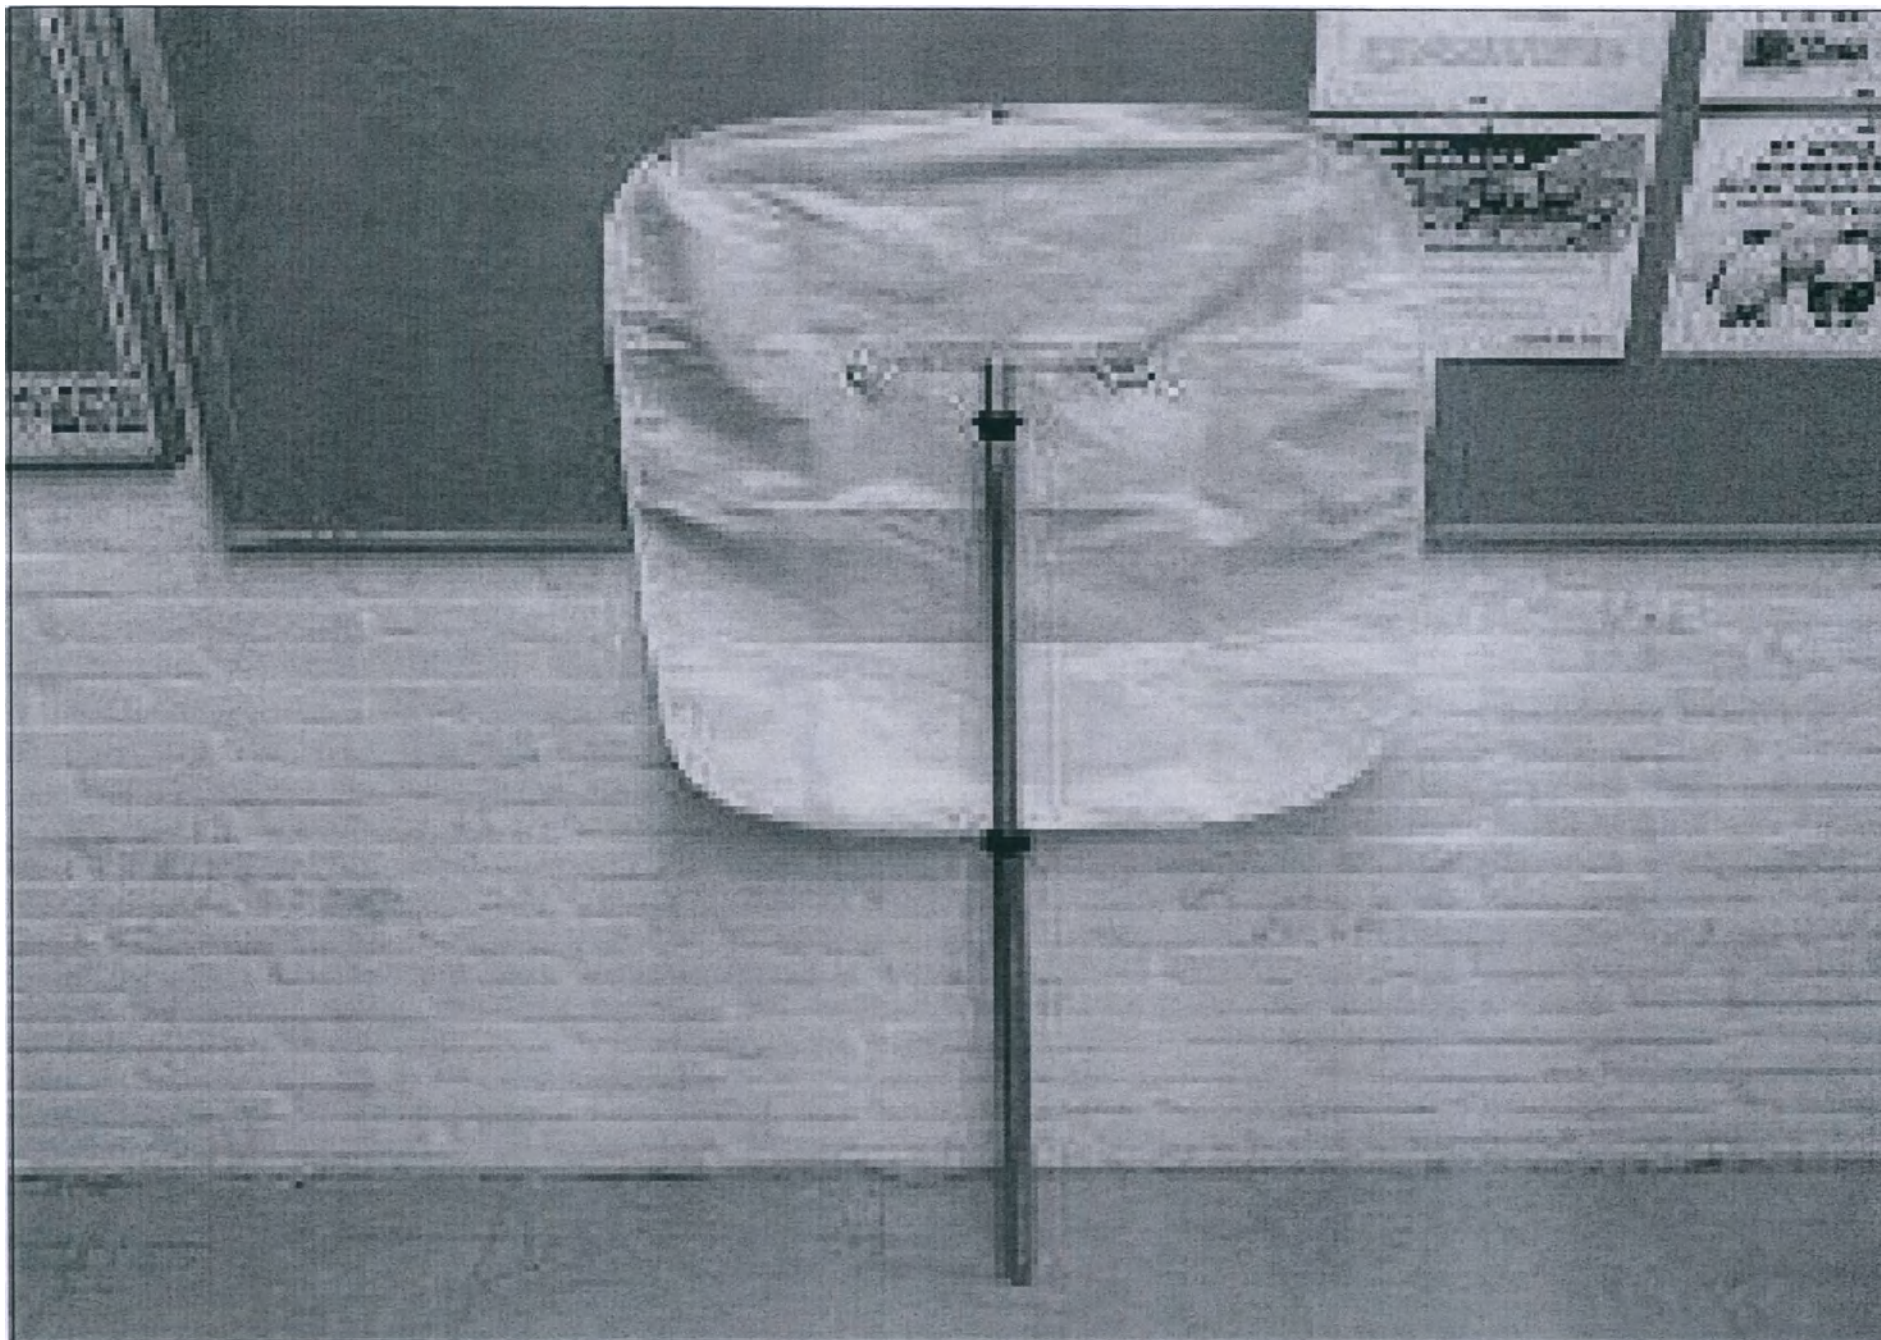


18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

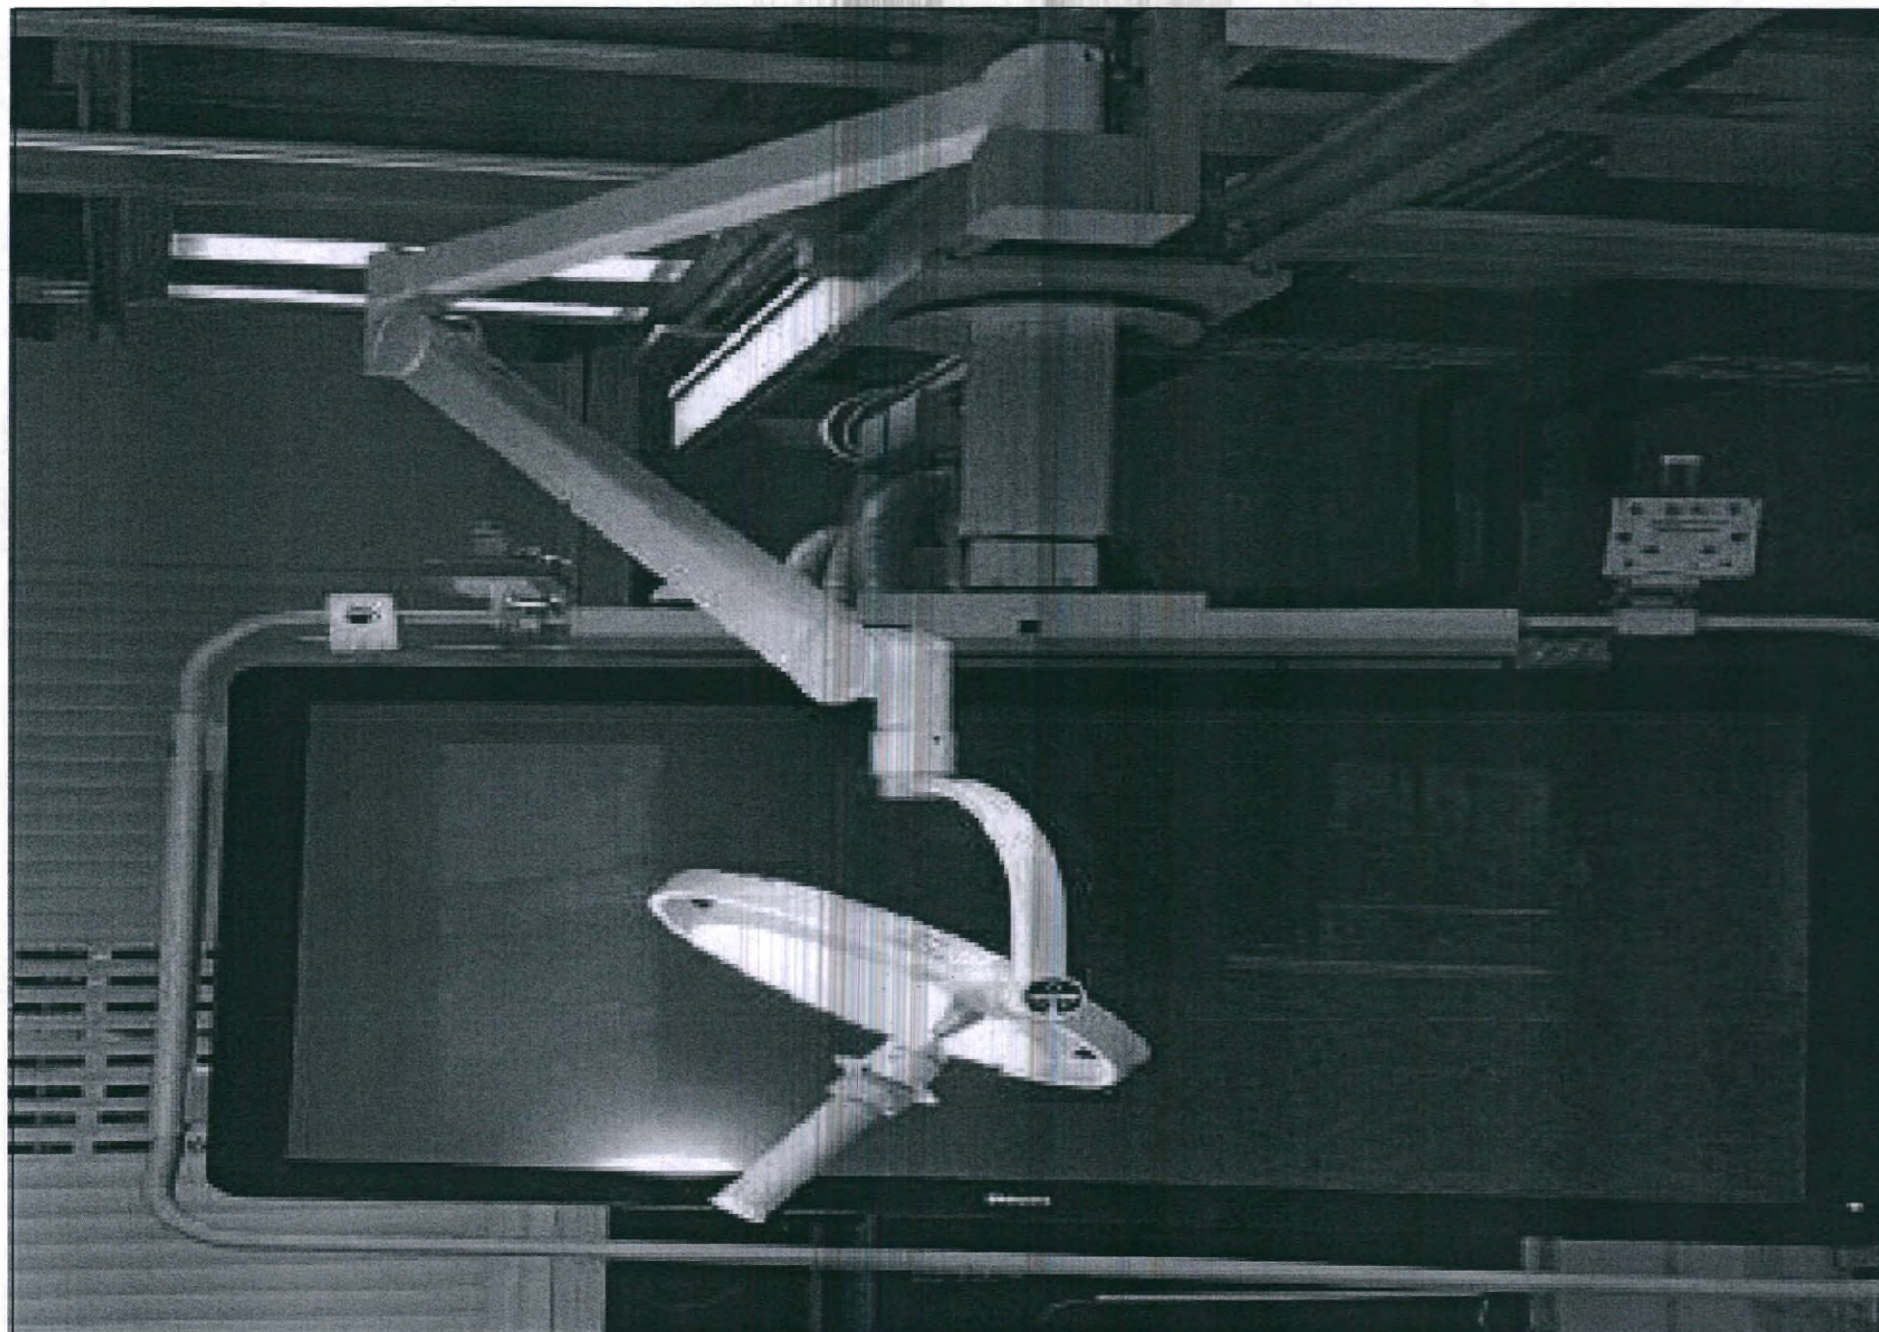

19. Лампа для осмотра.

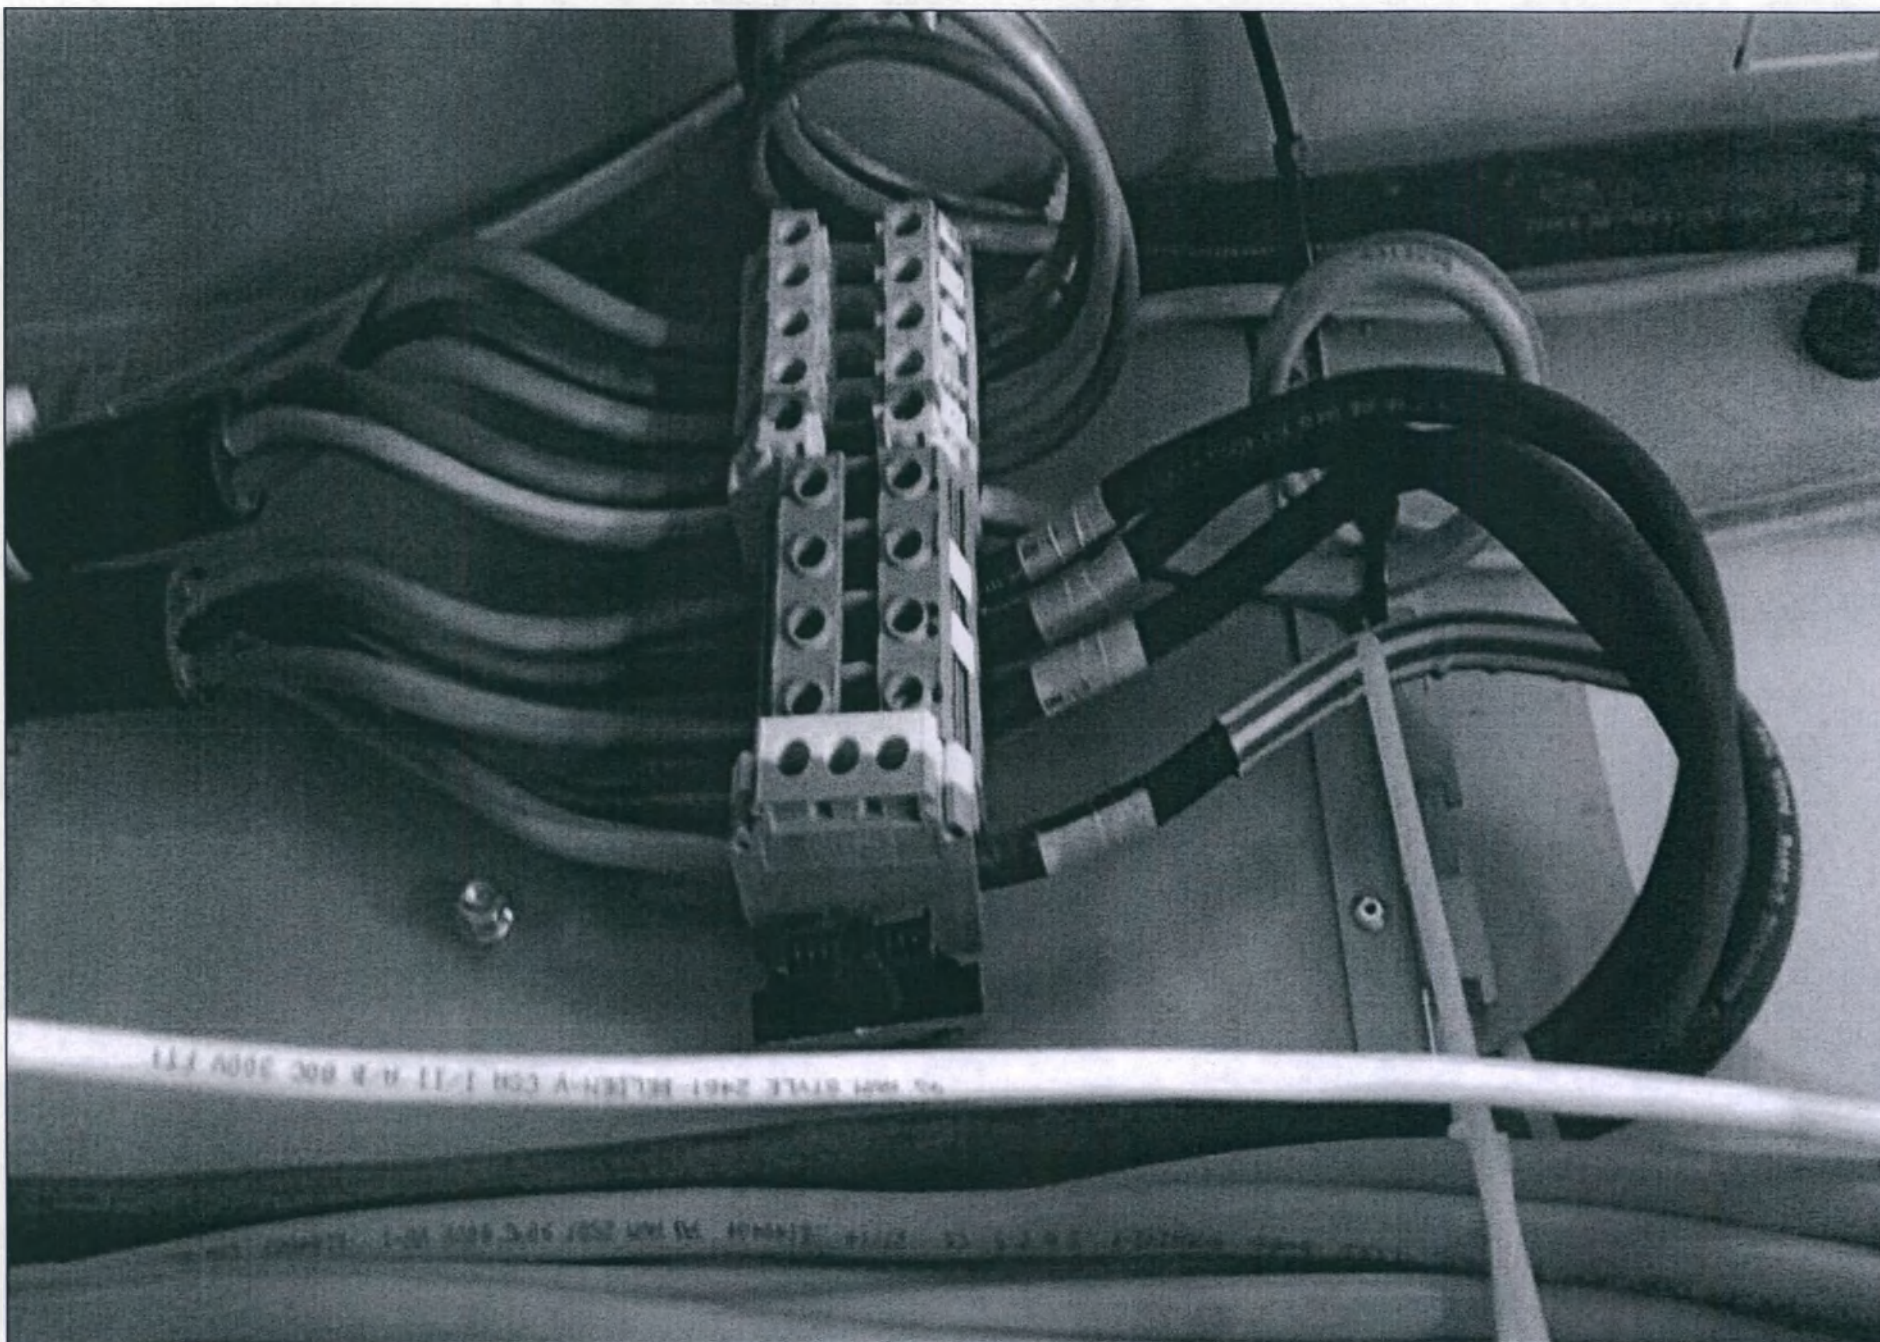

20. Кабели питания, 10 шт.

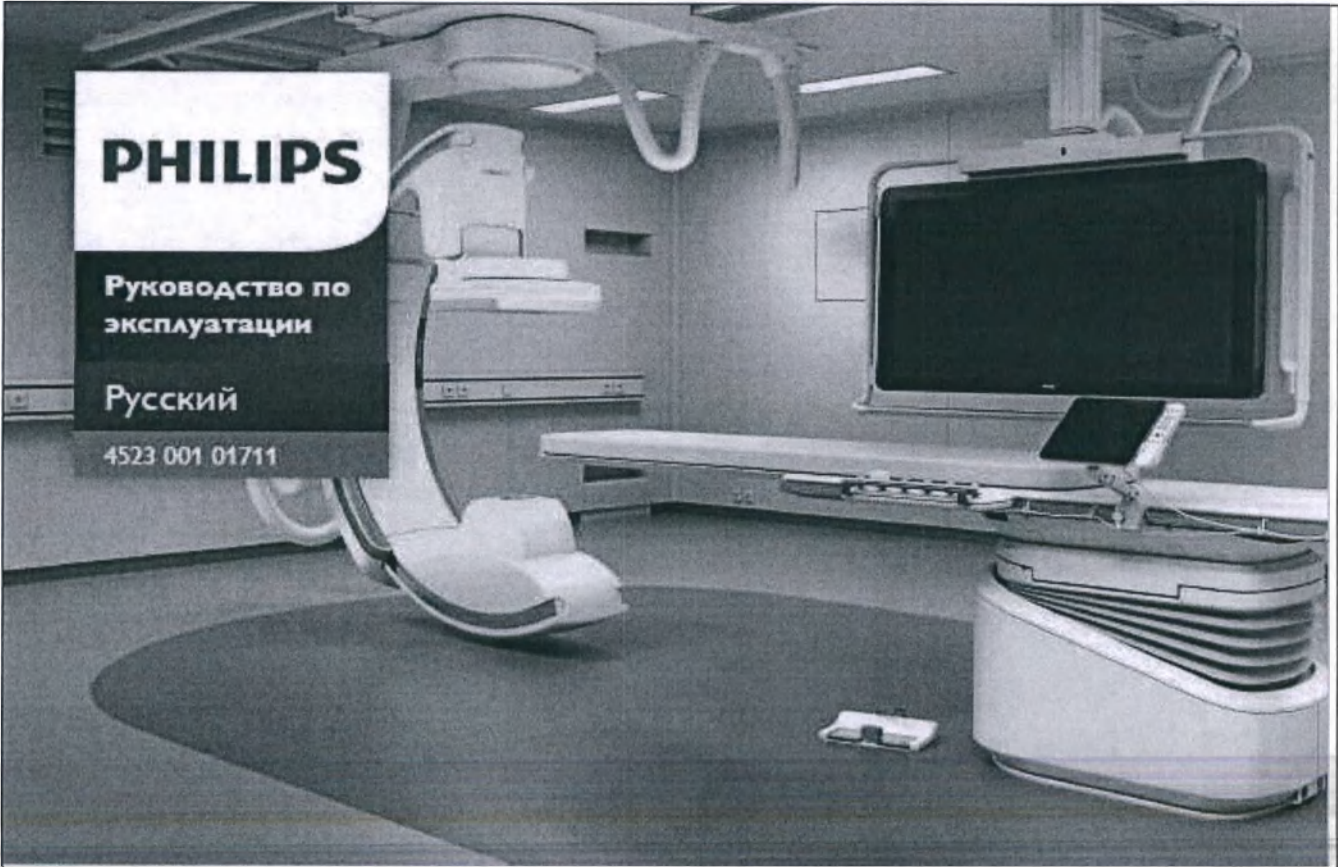

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский


4523 001 01711

Philips Azurion


Версия 2.2

21.в. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 7 M20 (вариант 1):

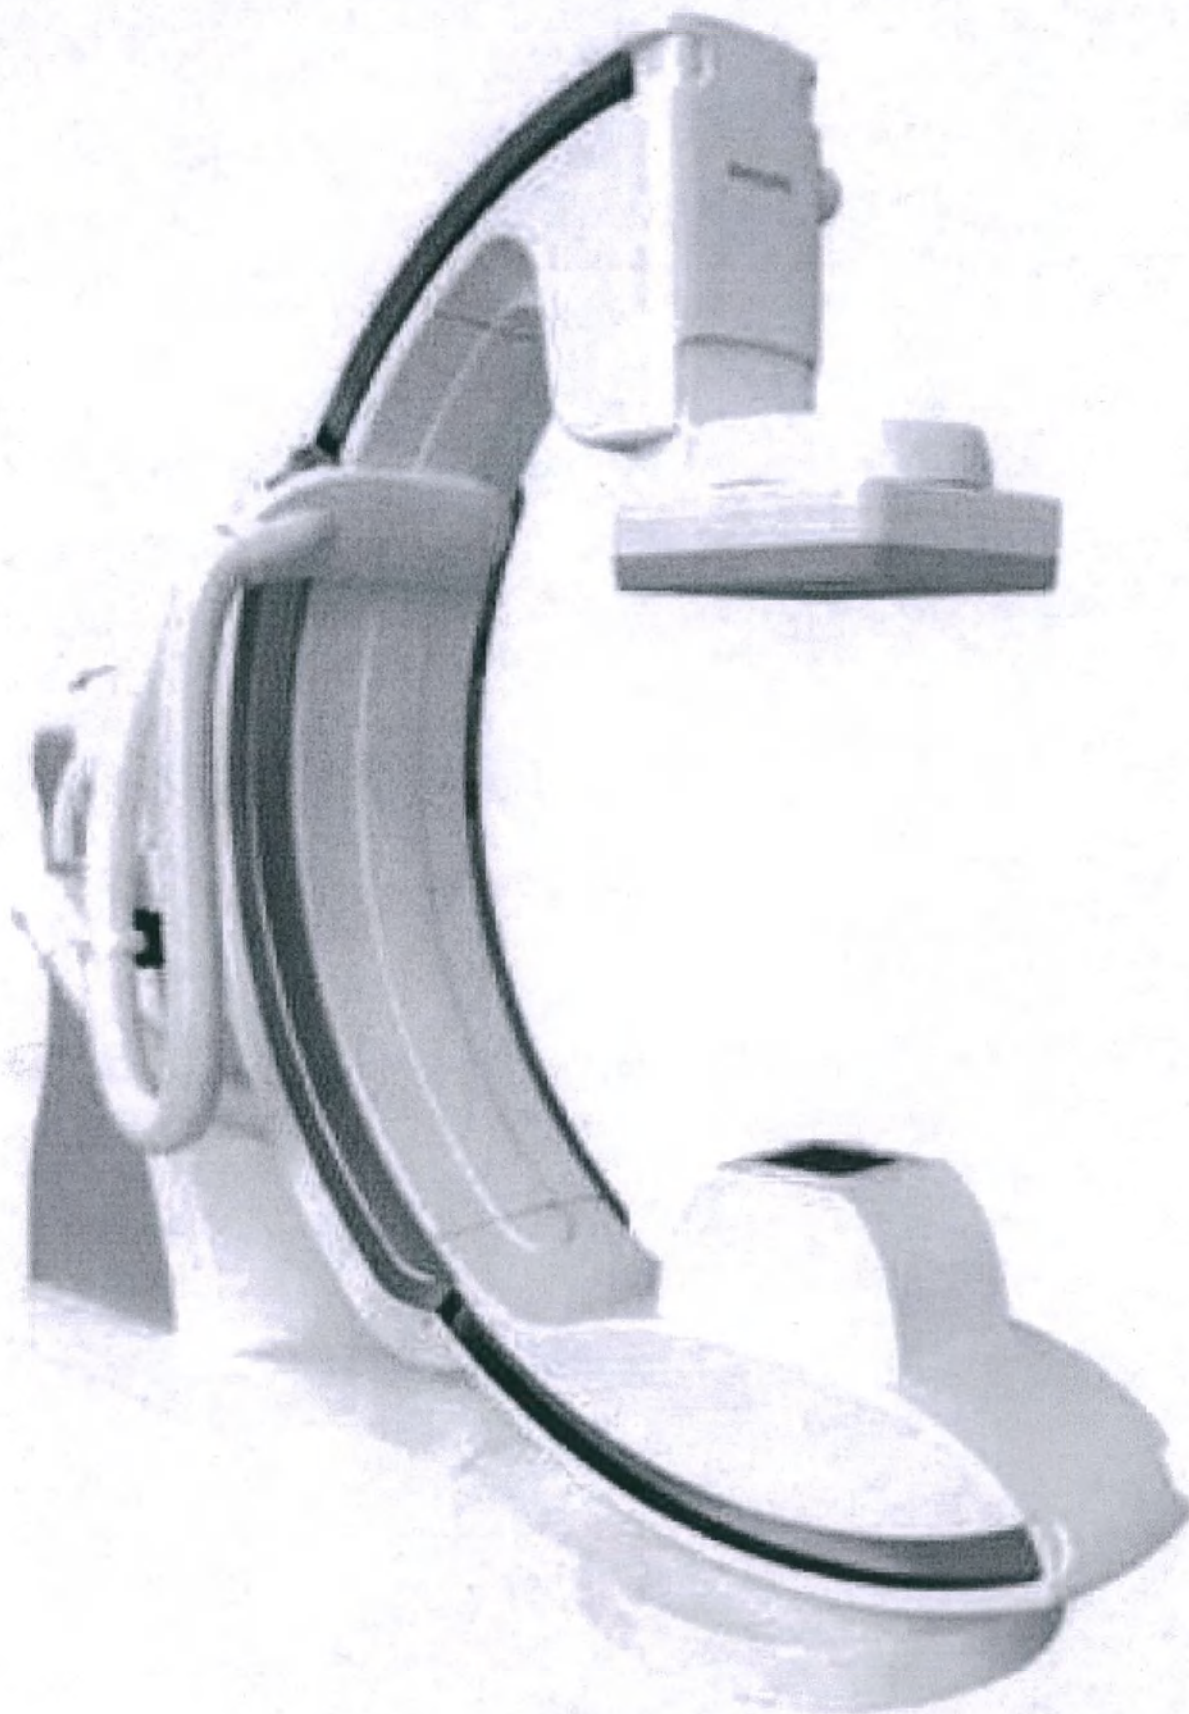


1. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

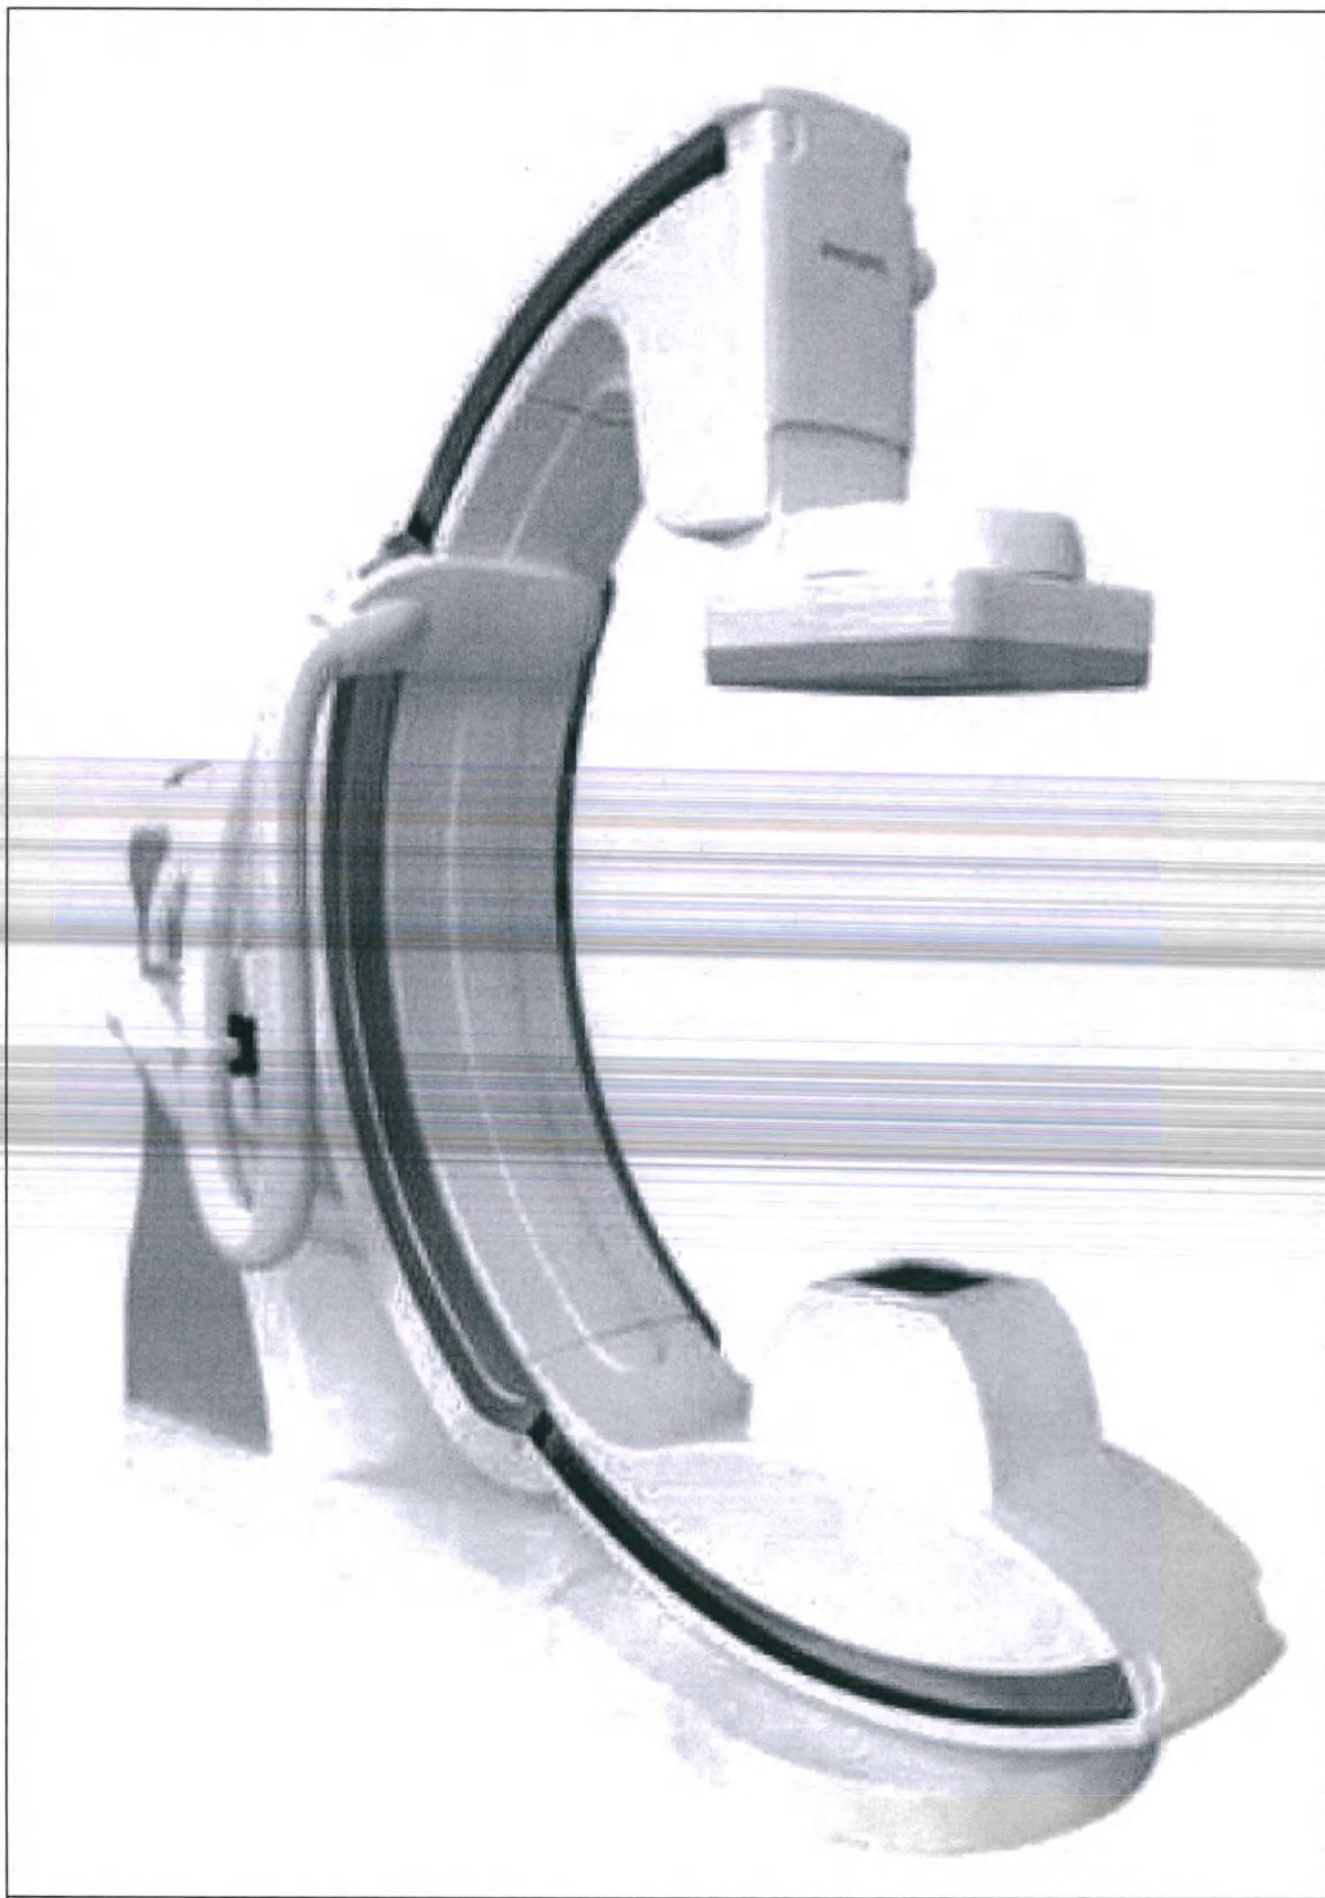


1.а. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

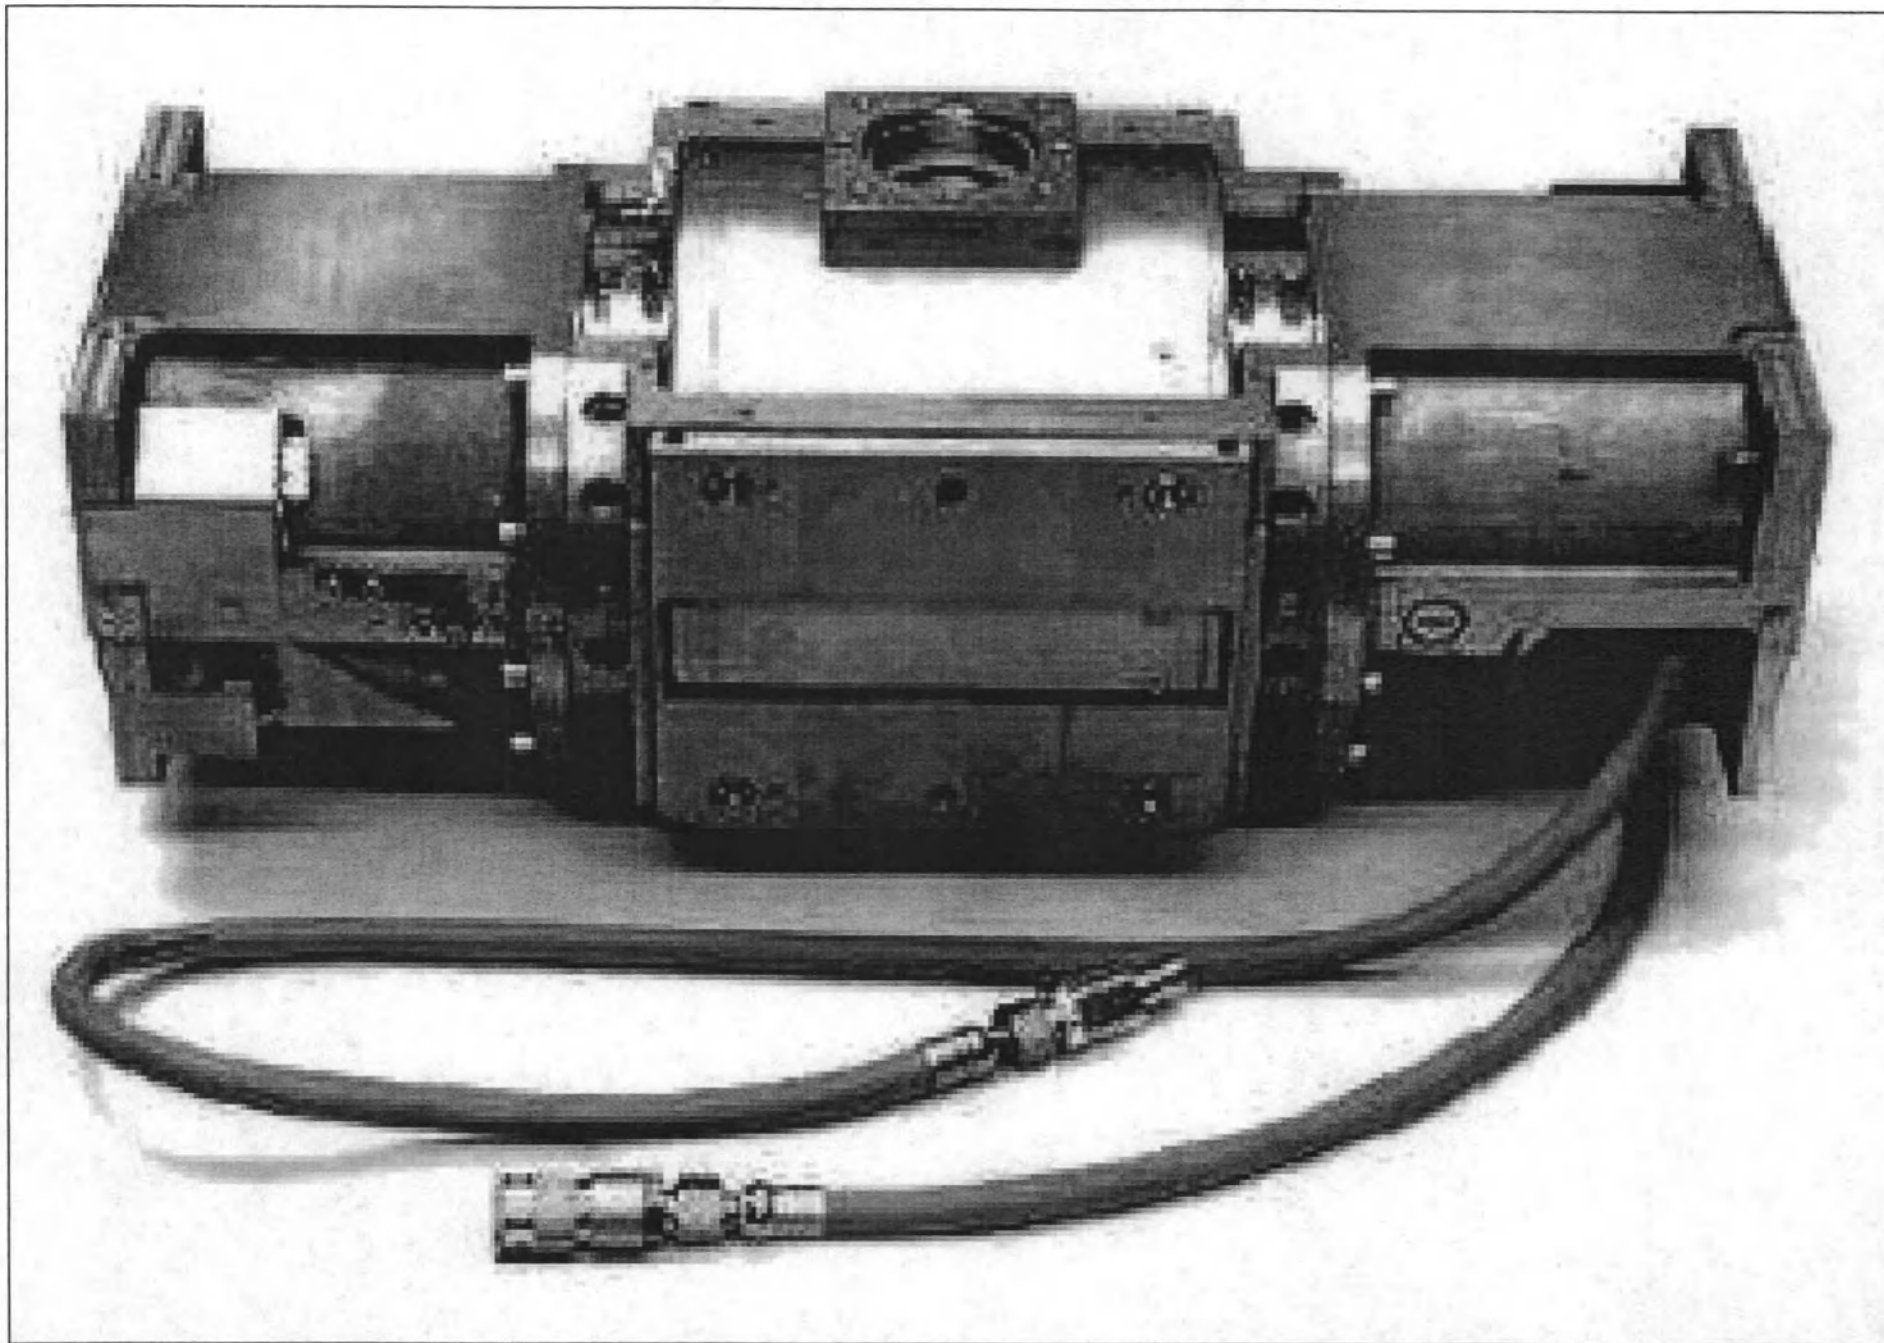


1.6. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

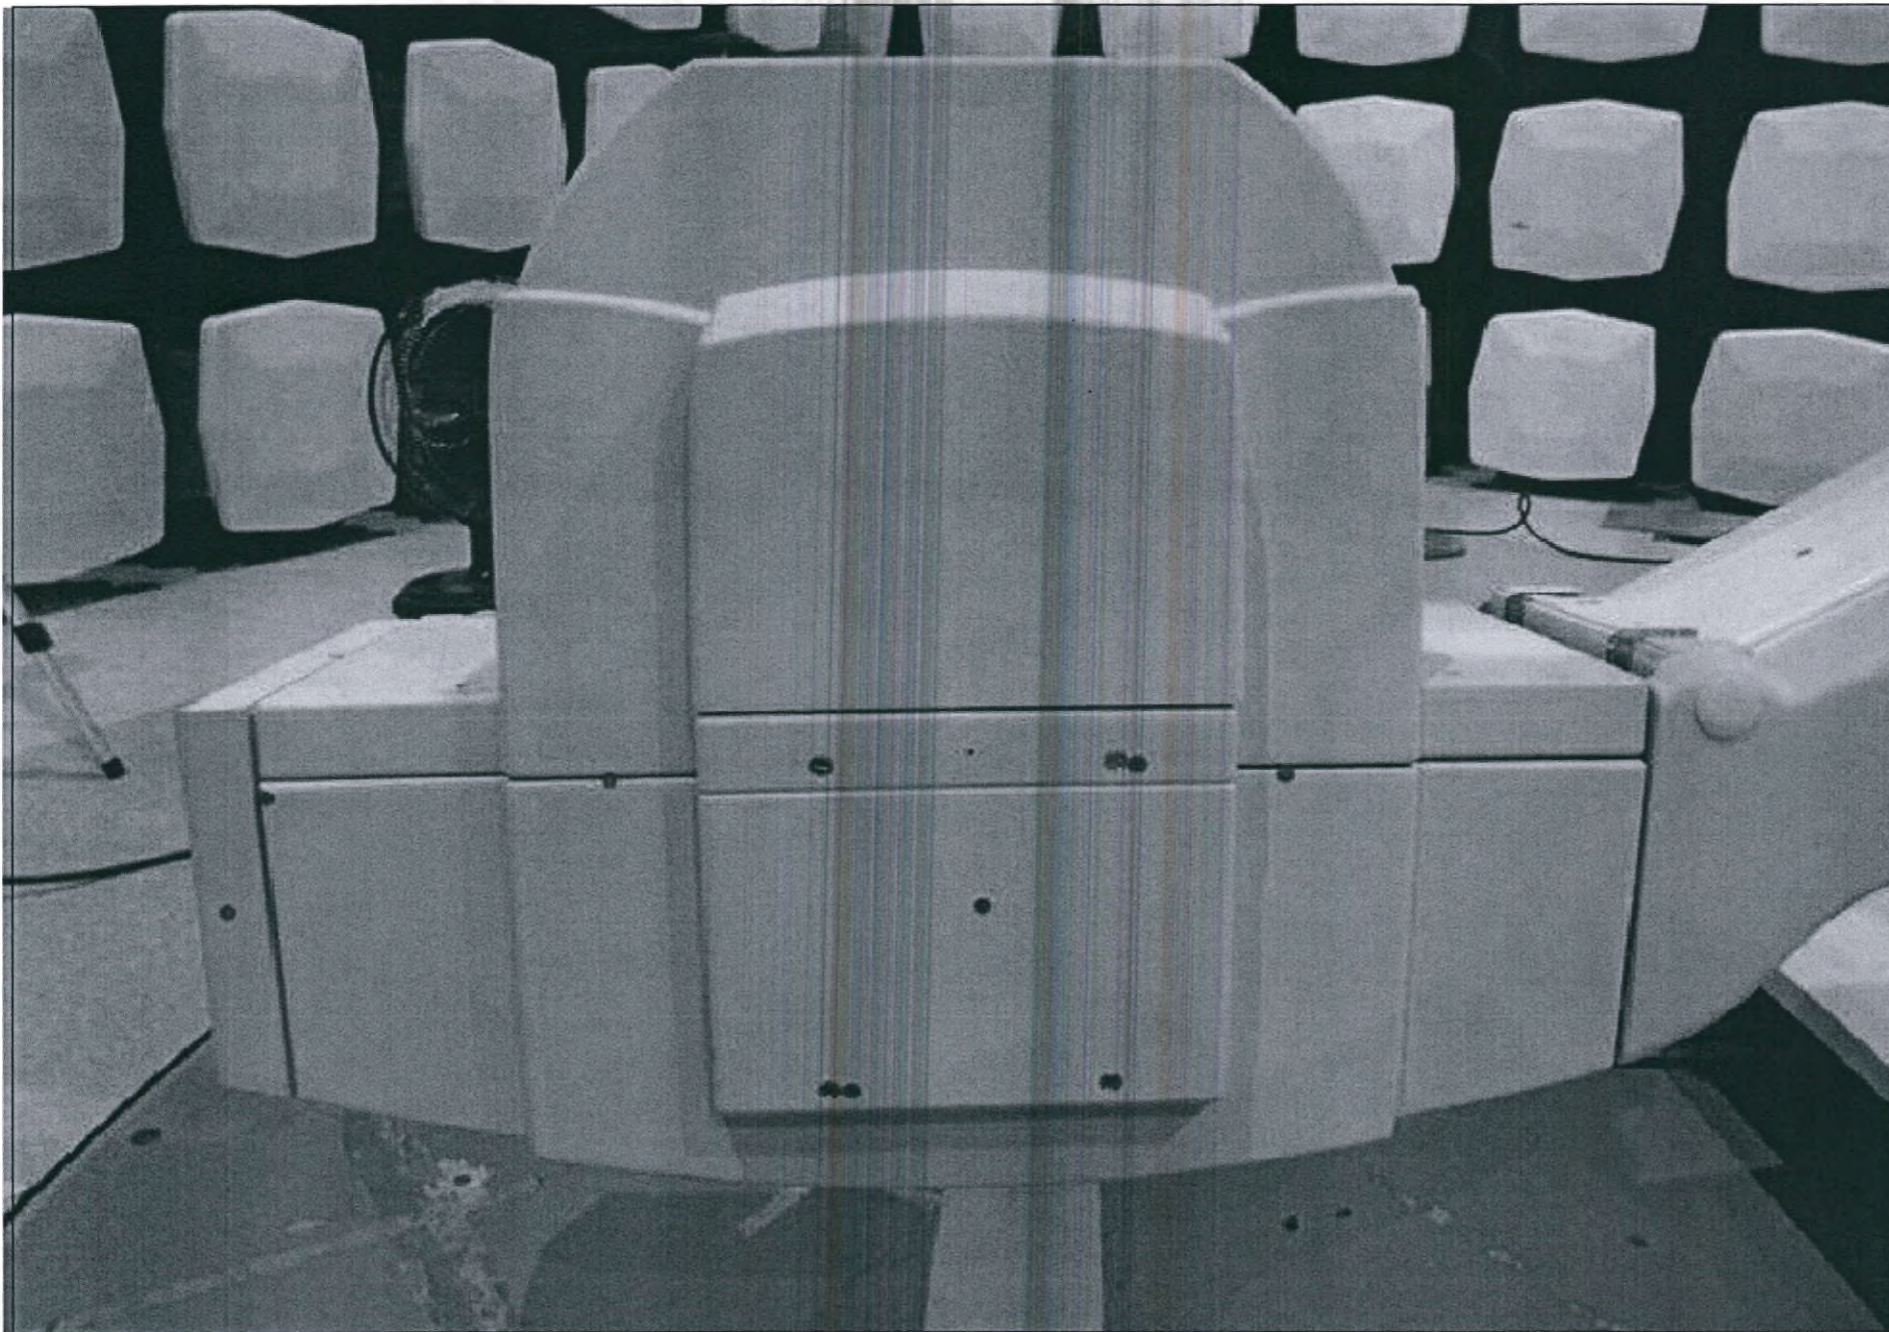


1.в. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

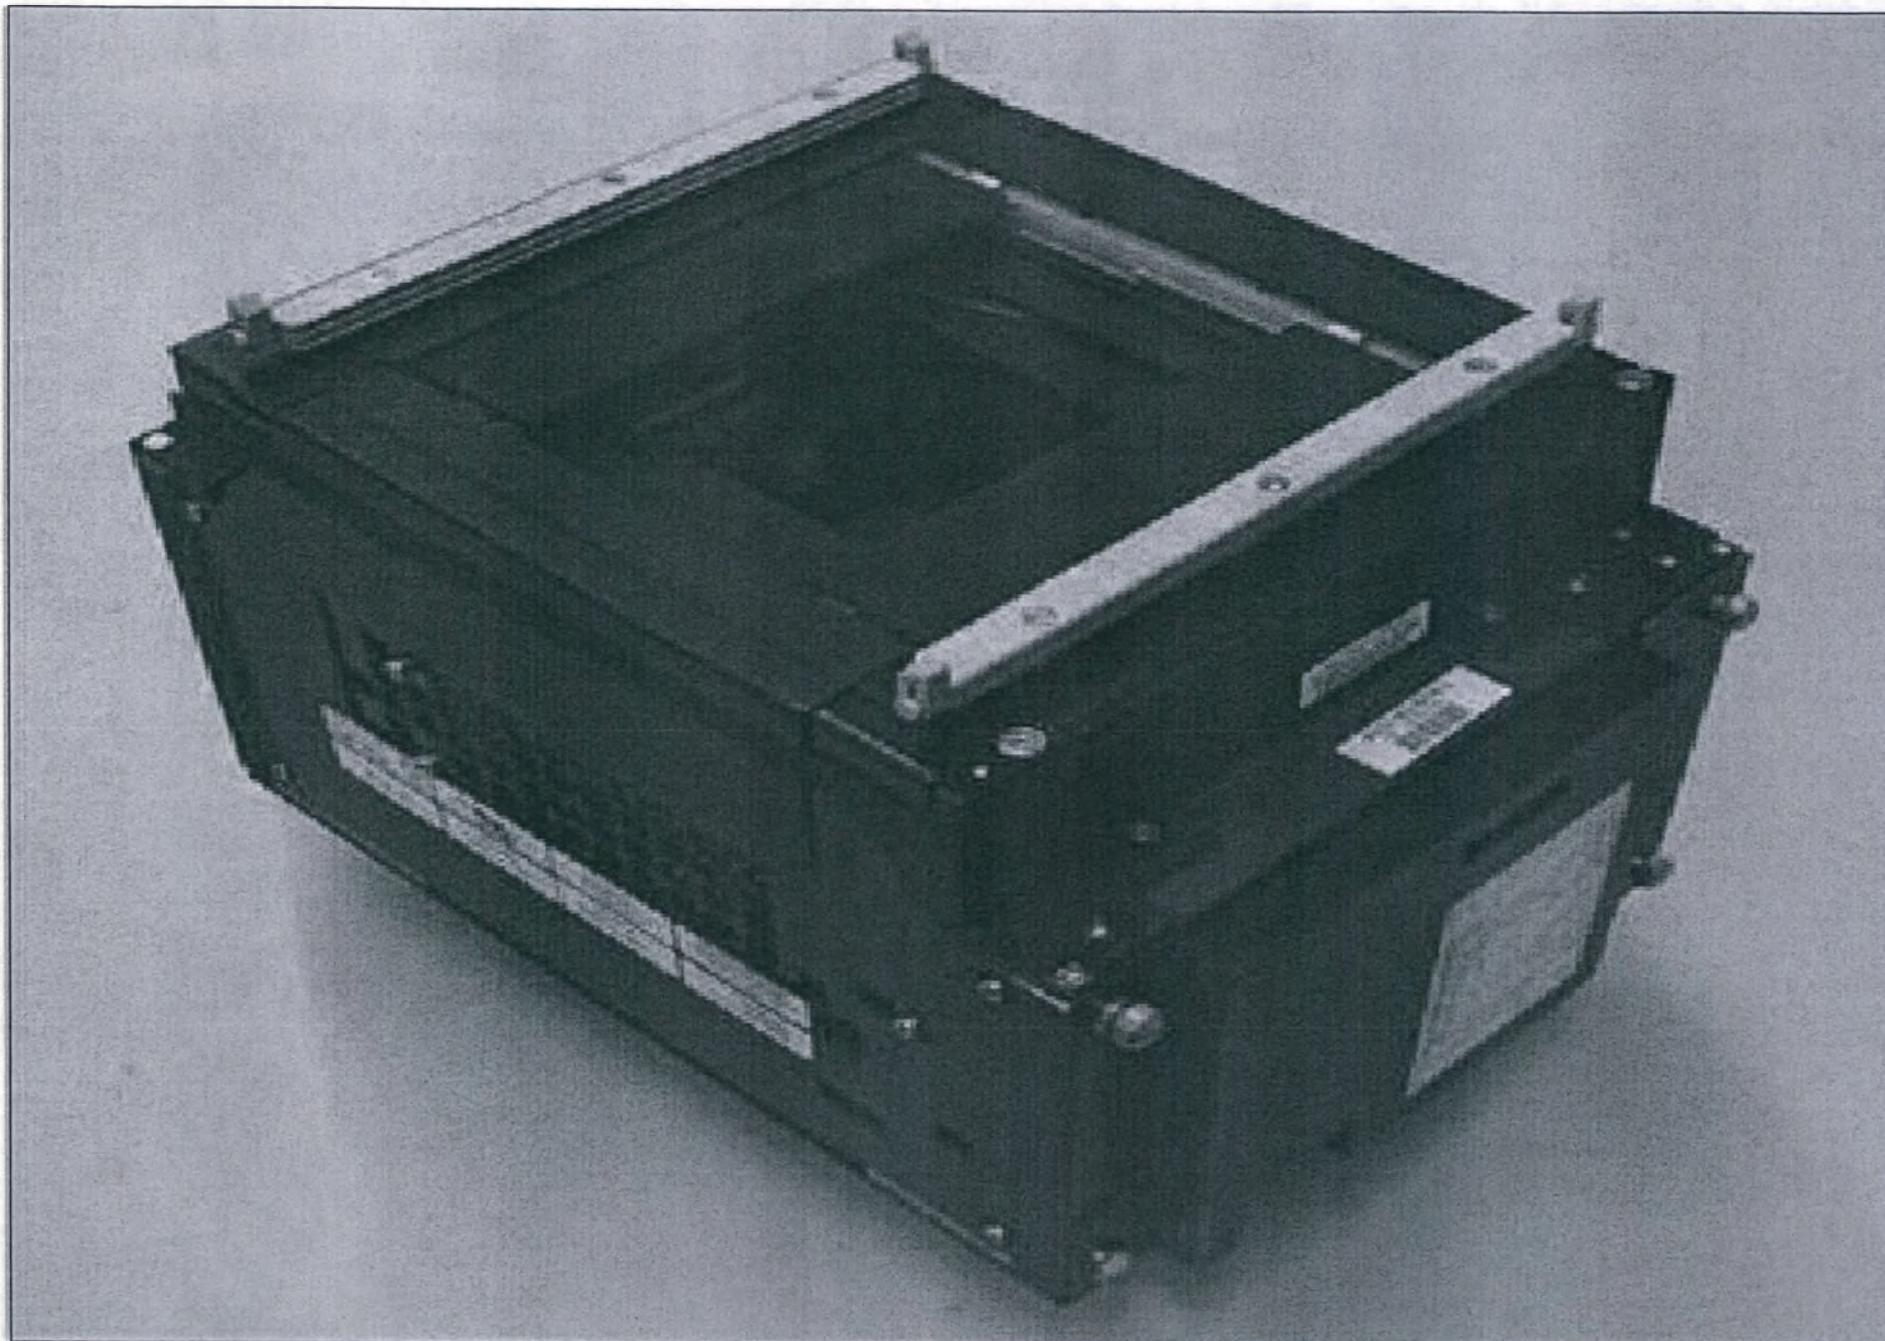


1.2. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

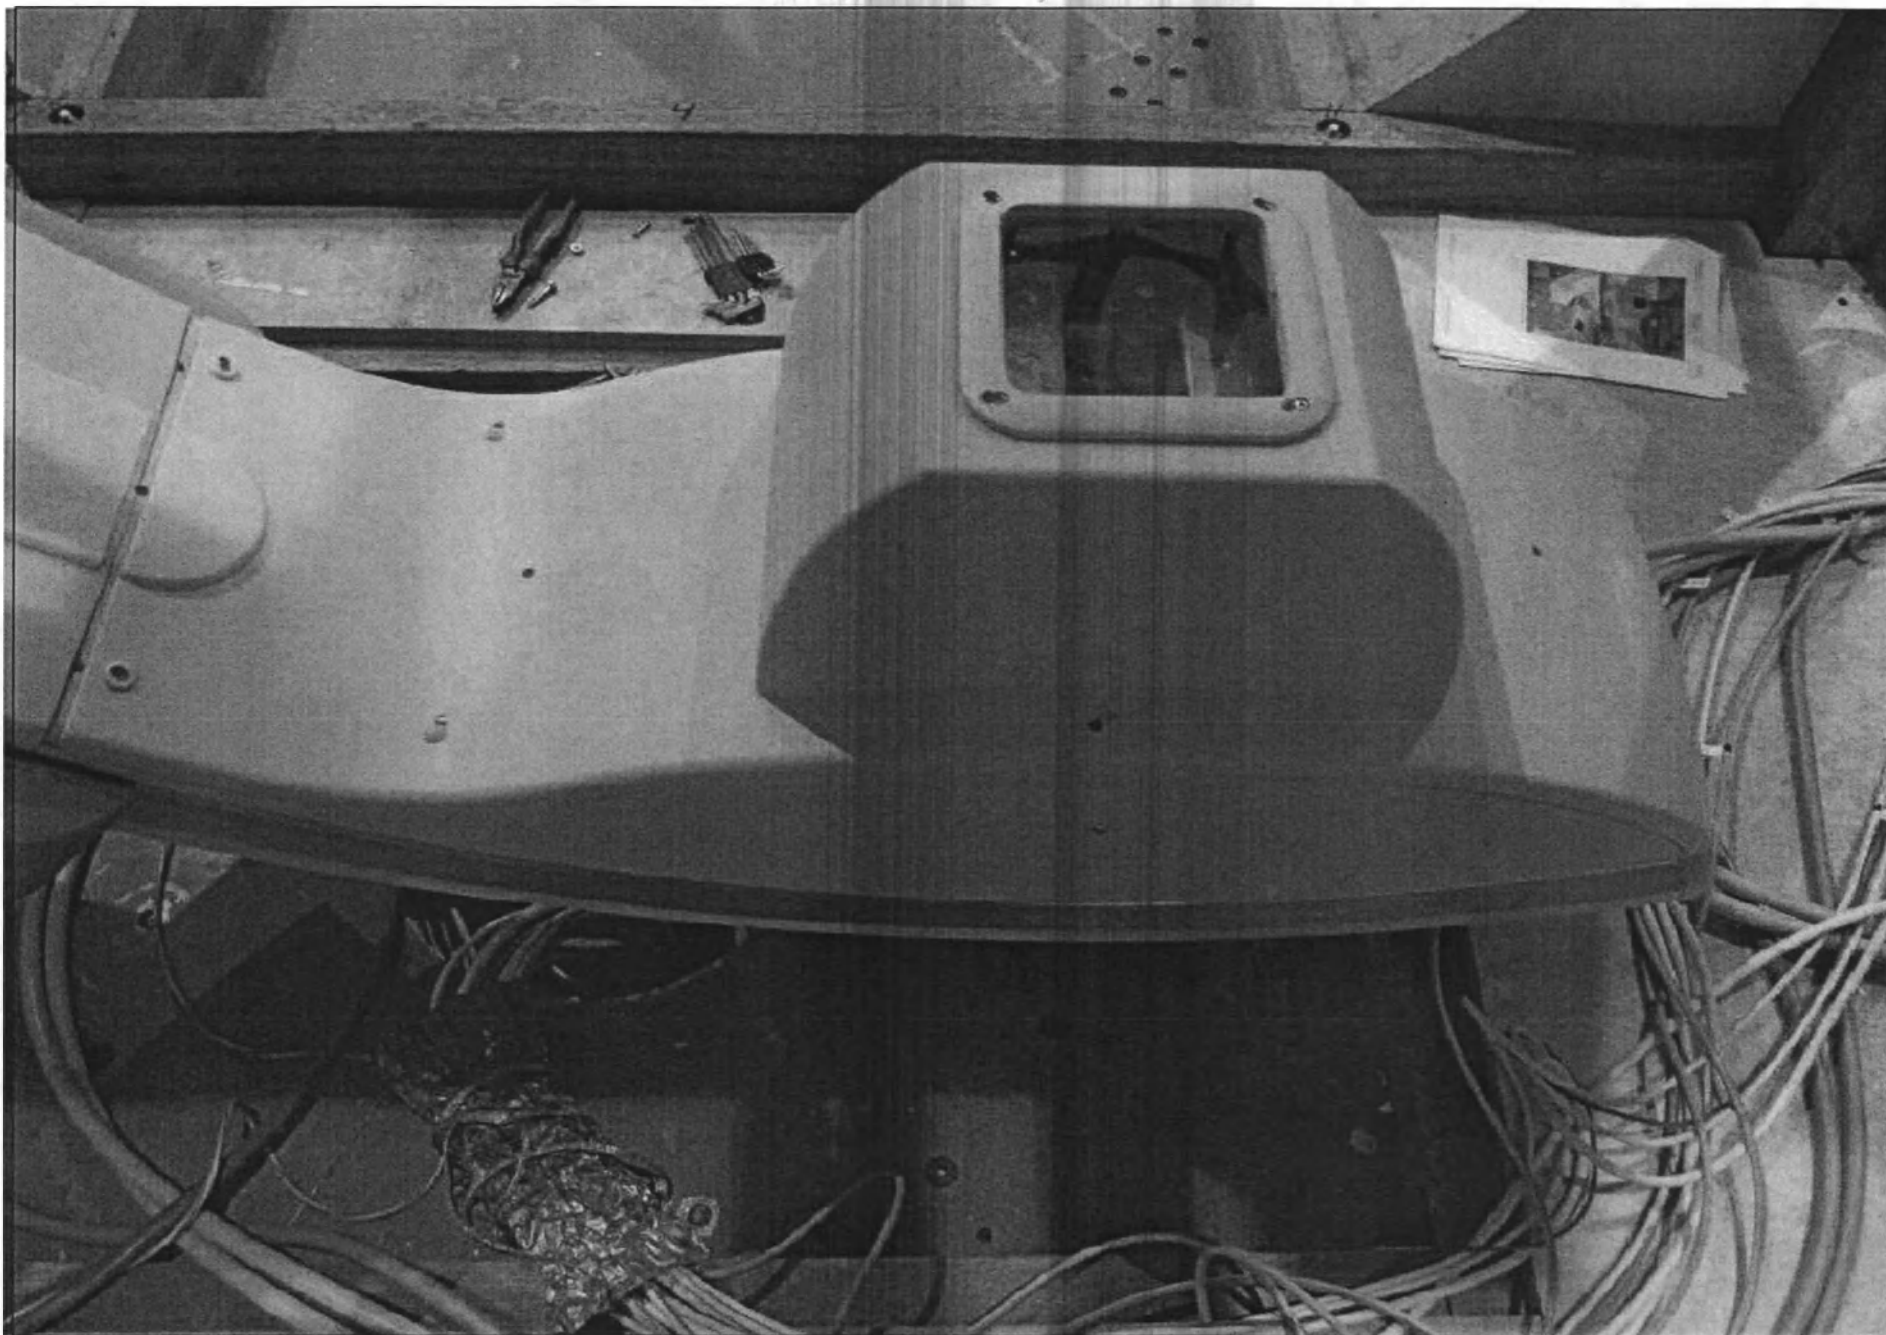


1.д. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

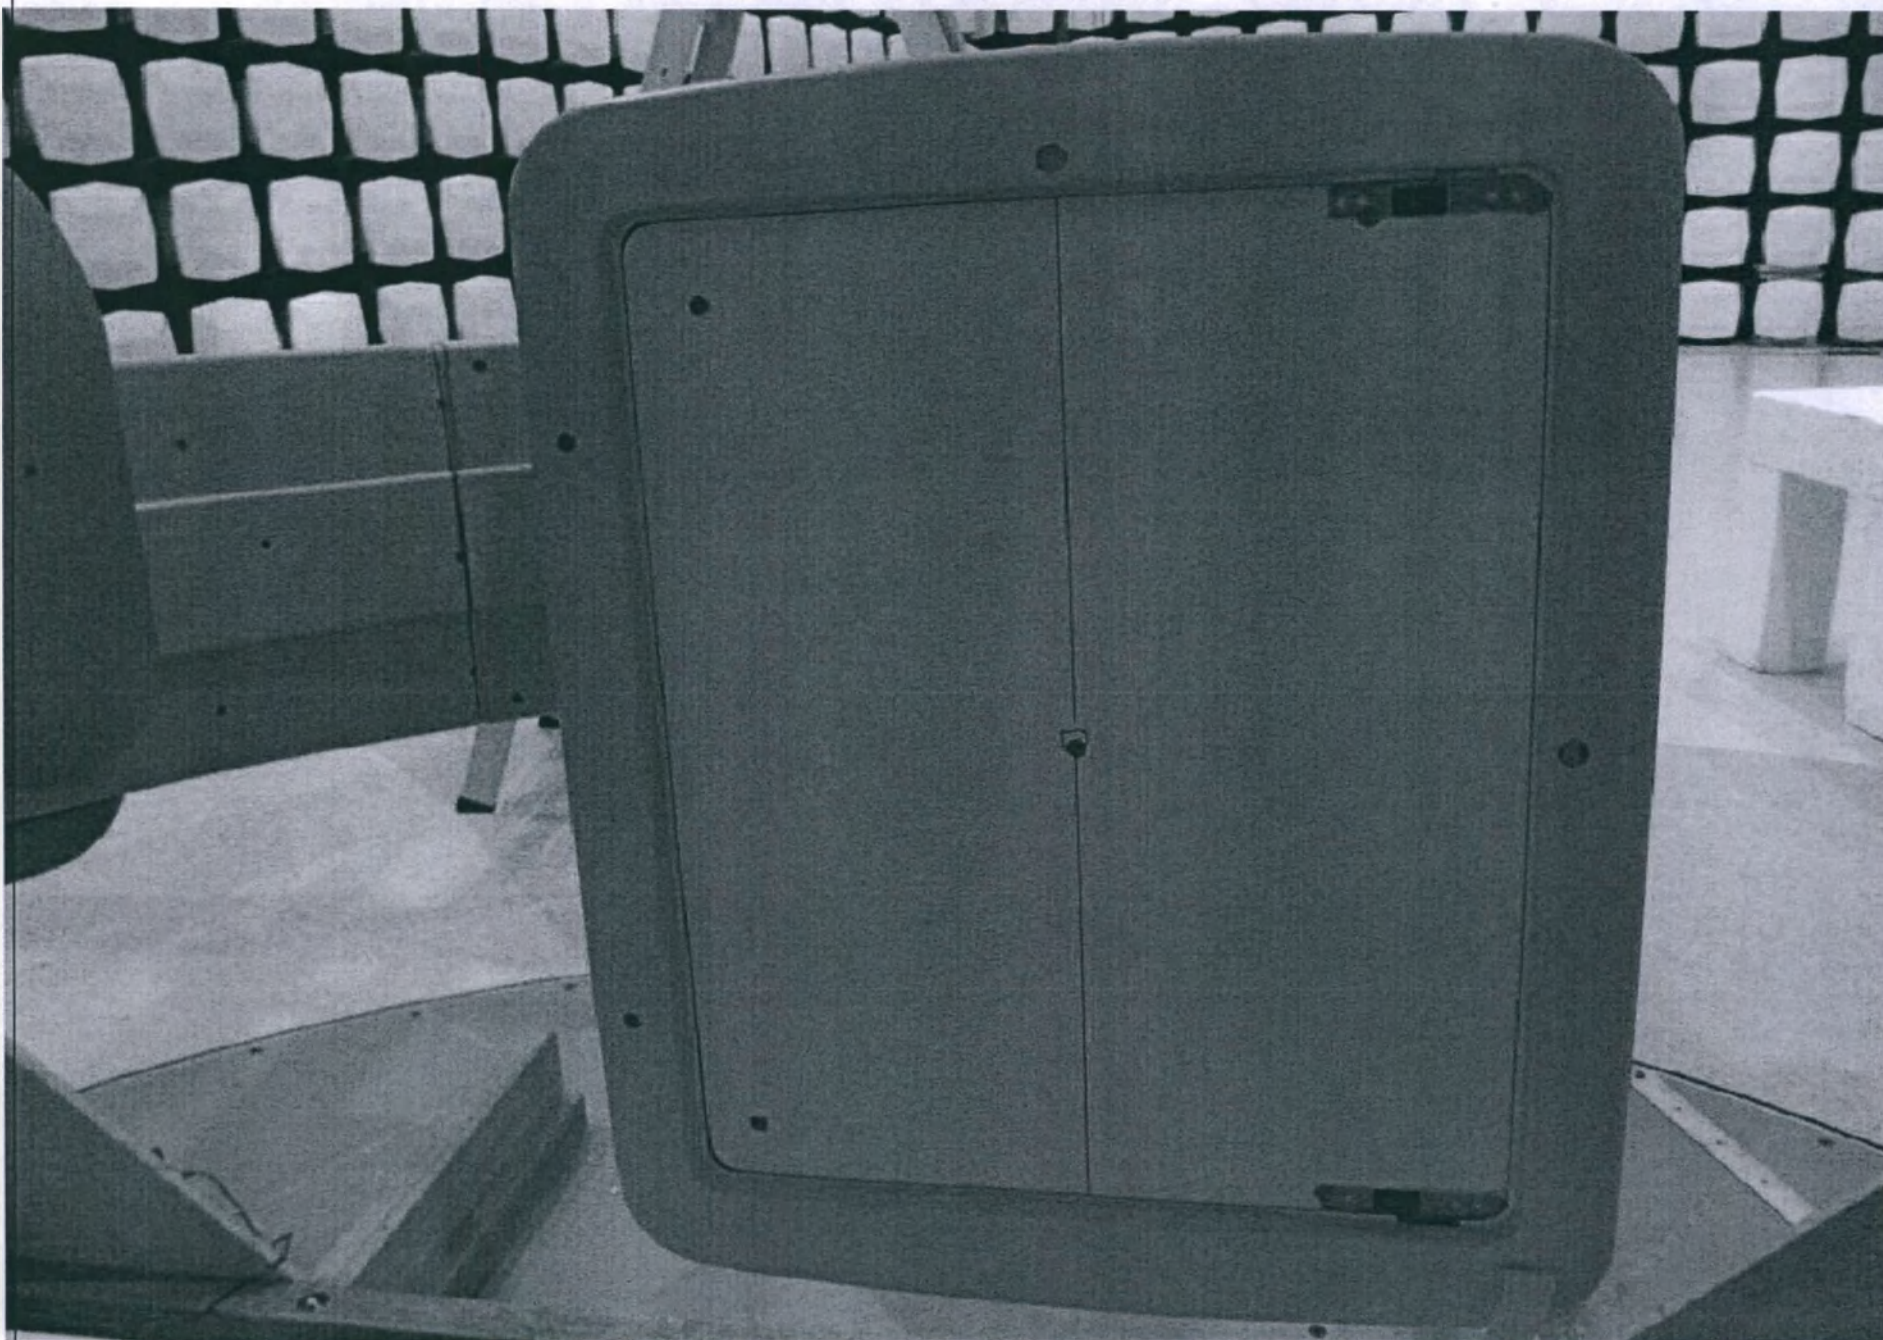


1.е. Модуль С-дуги в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

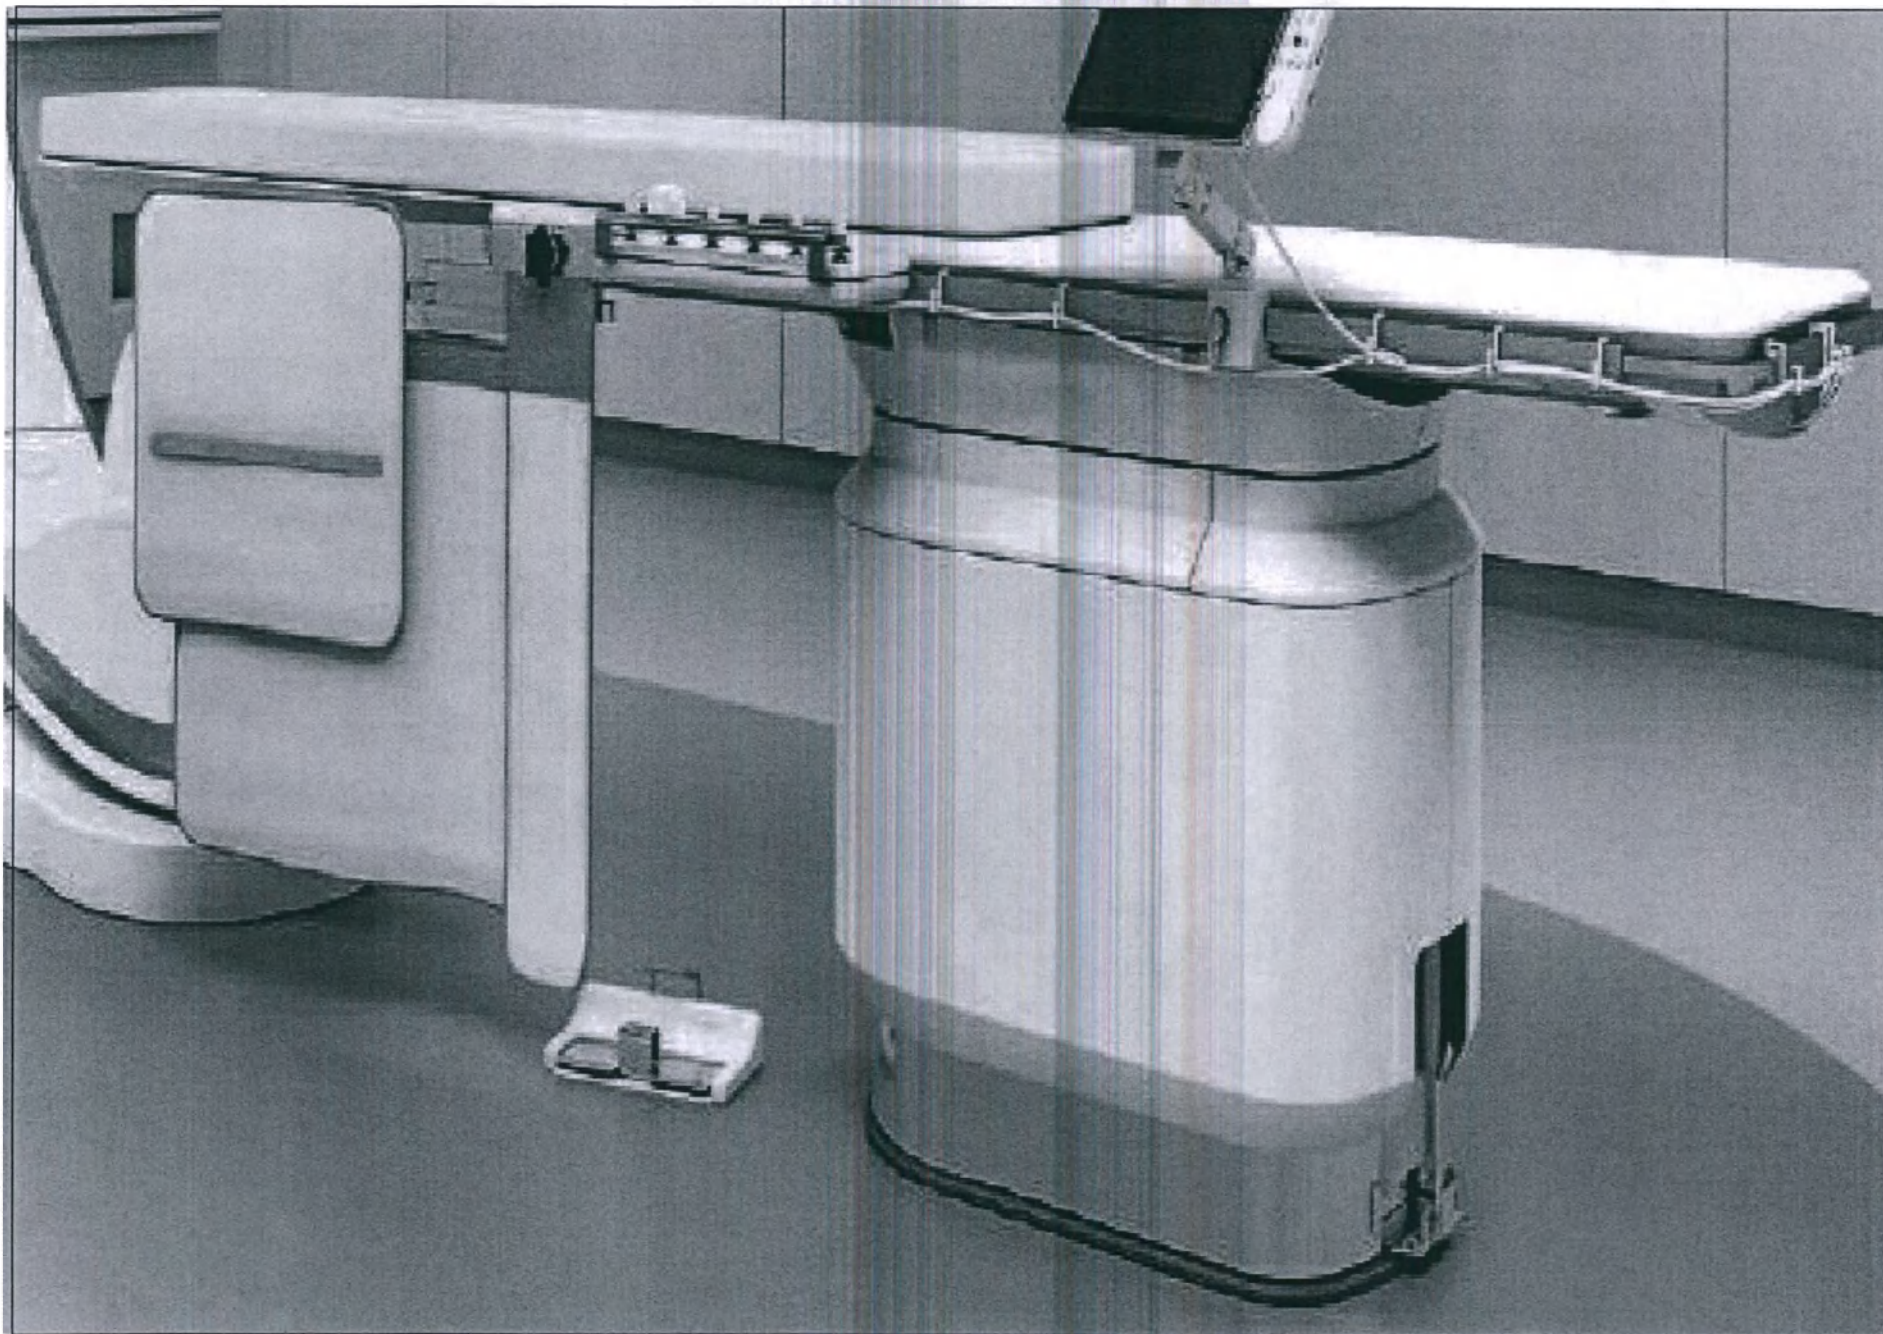


2.а. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

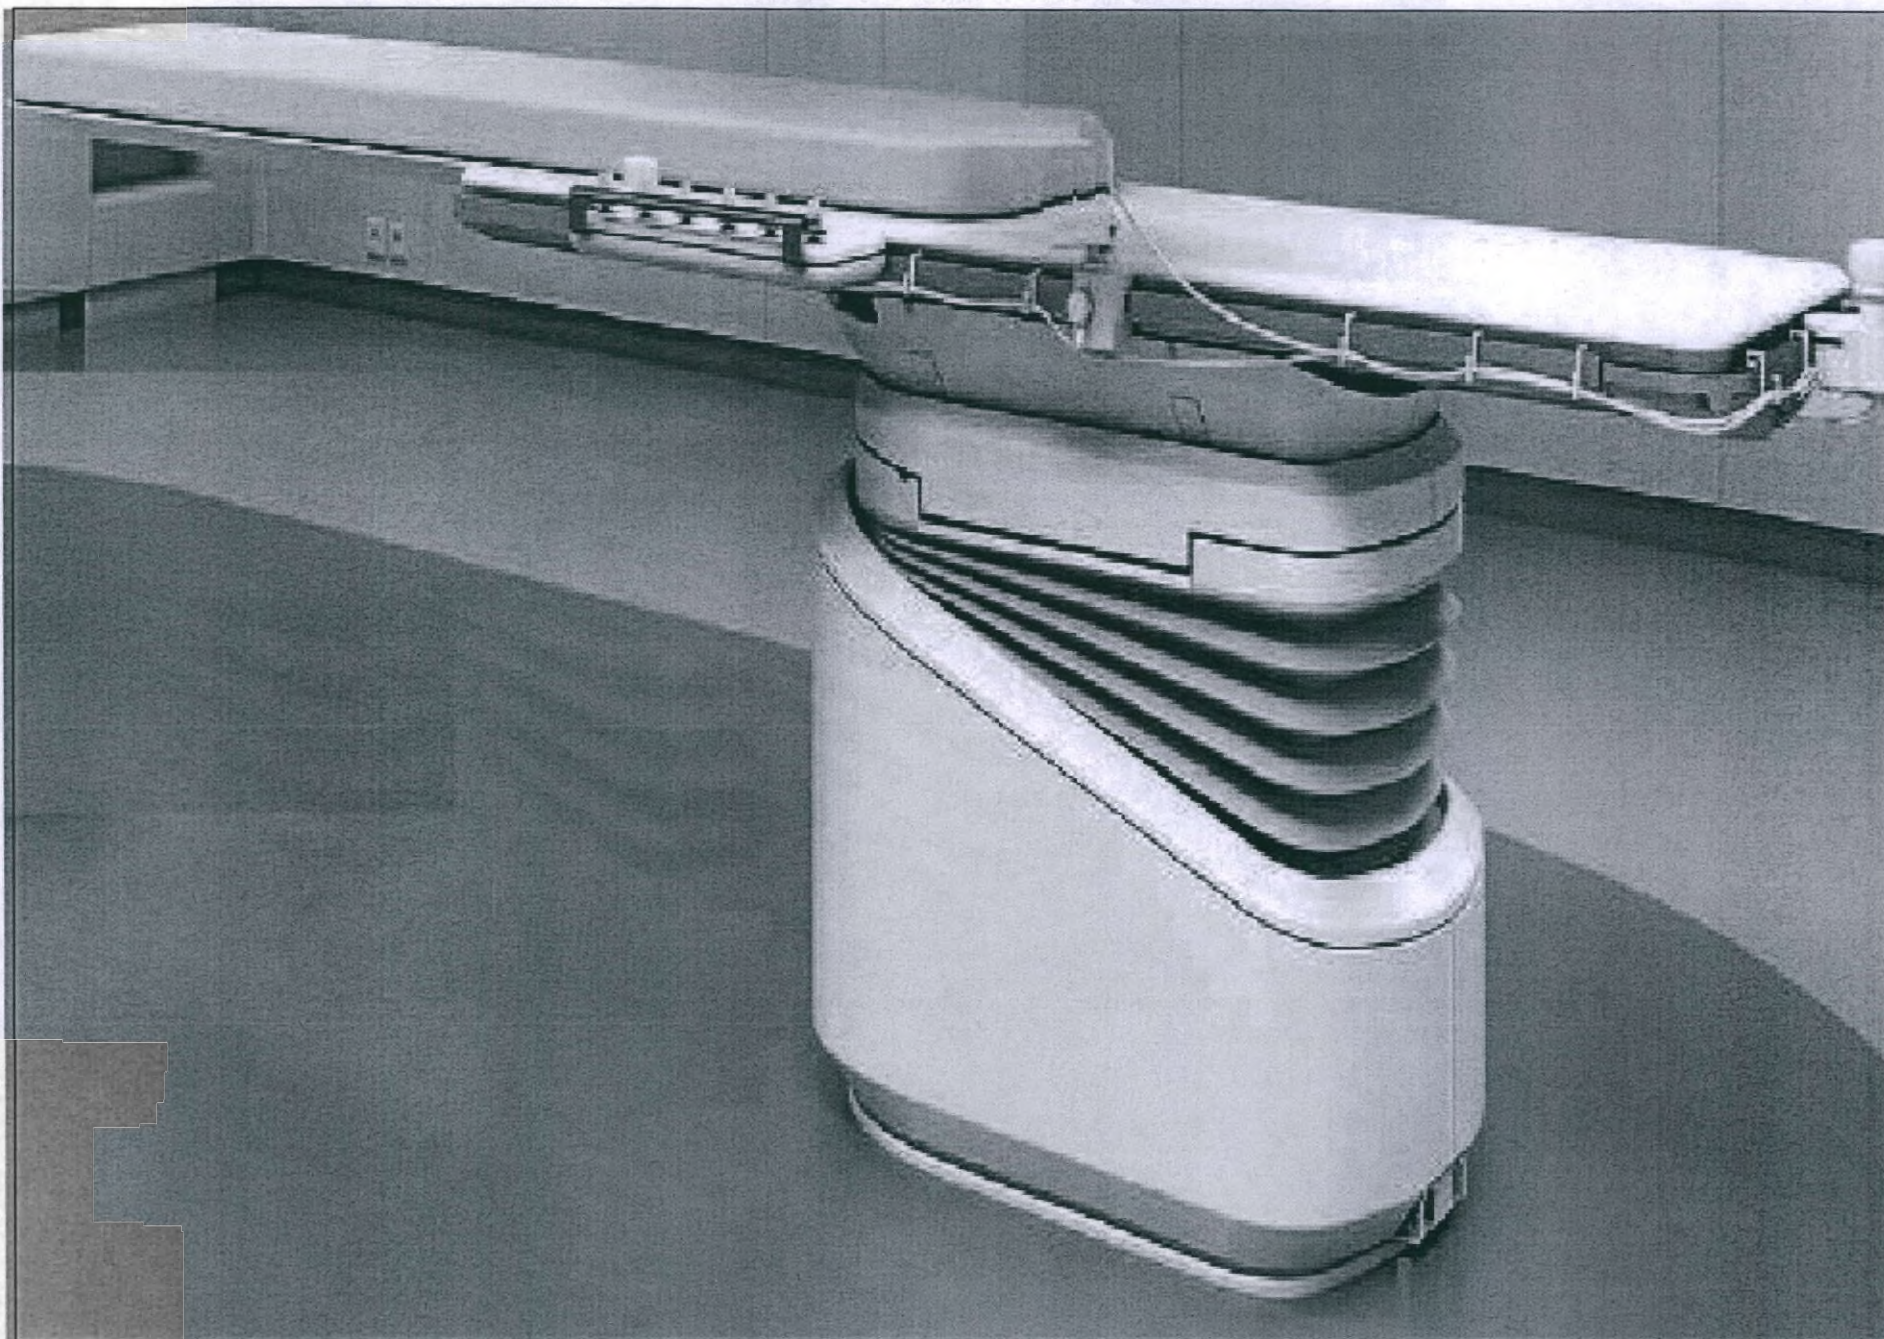


2.6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

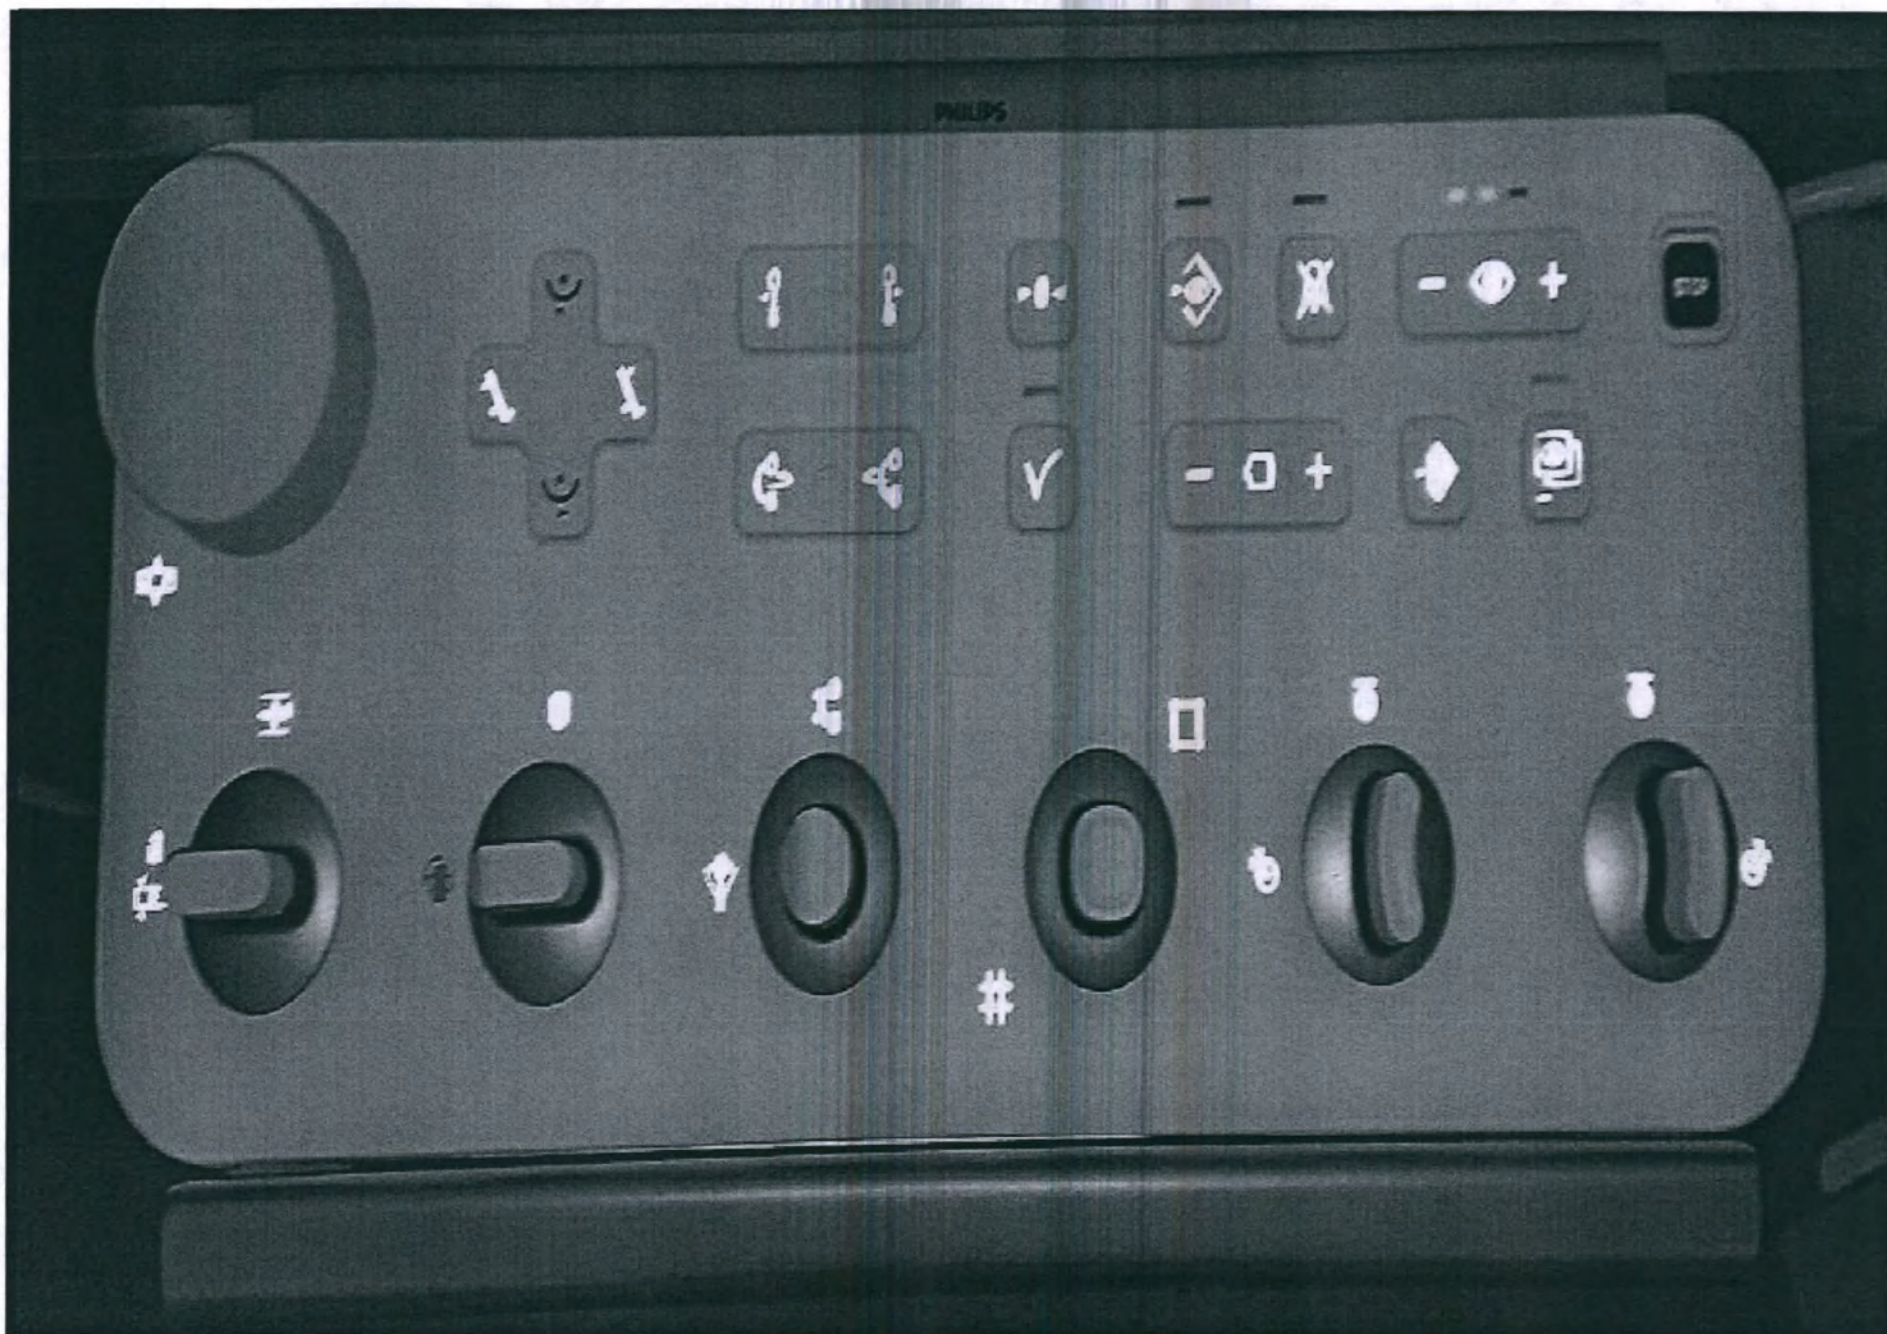


3. Модуль управления, не более 4 шт.

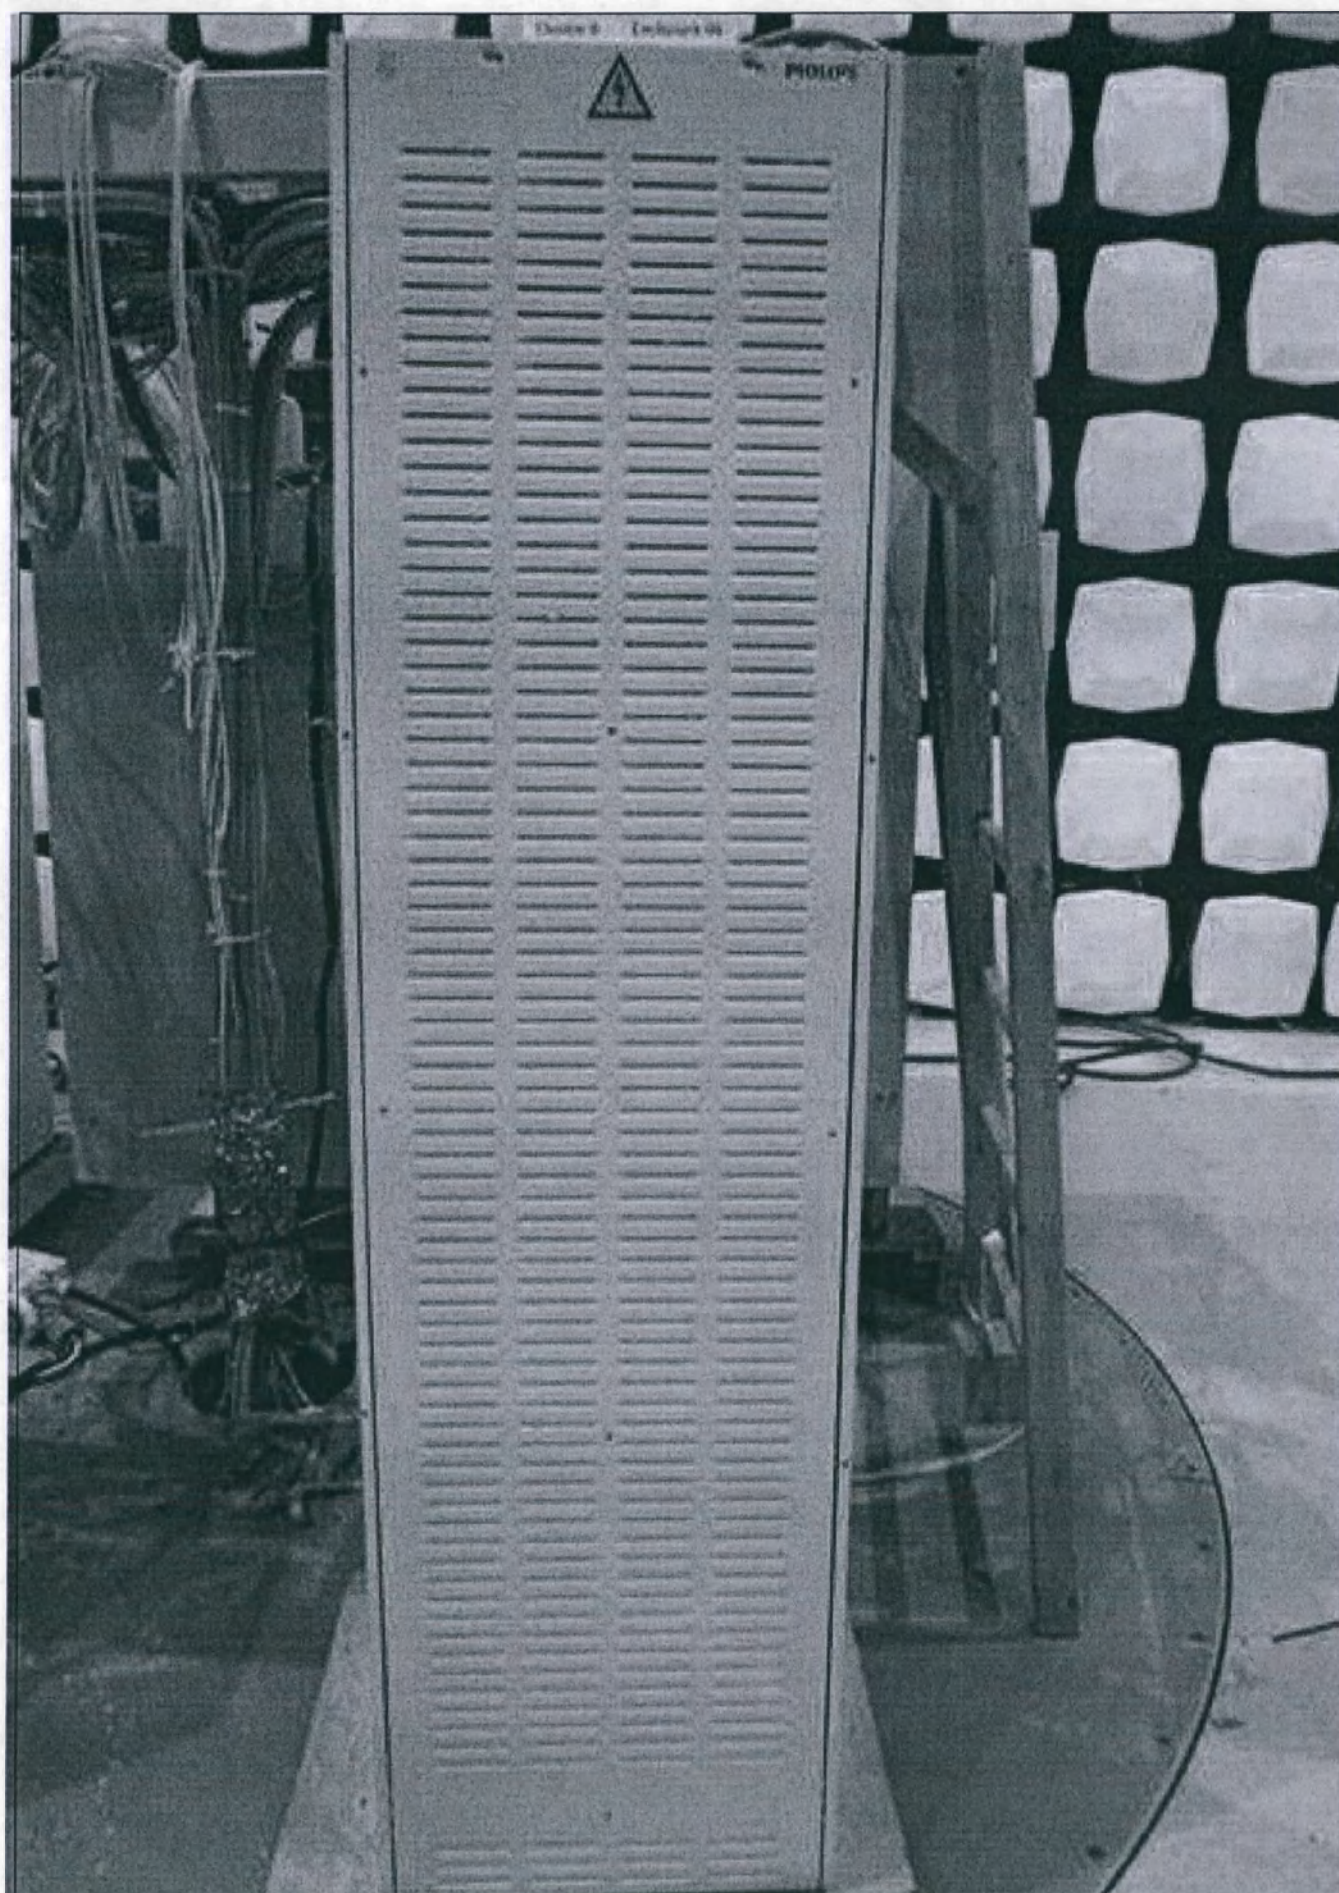


4.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

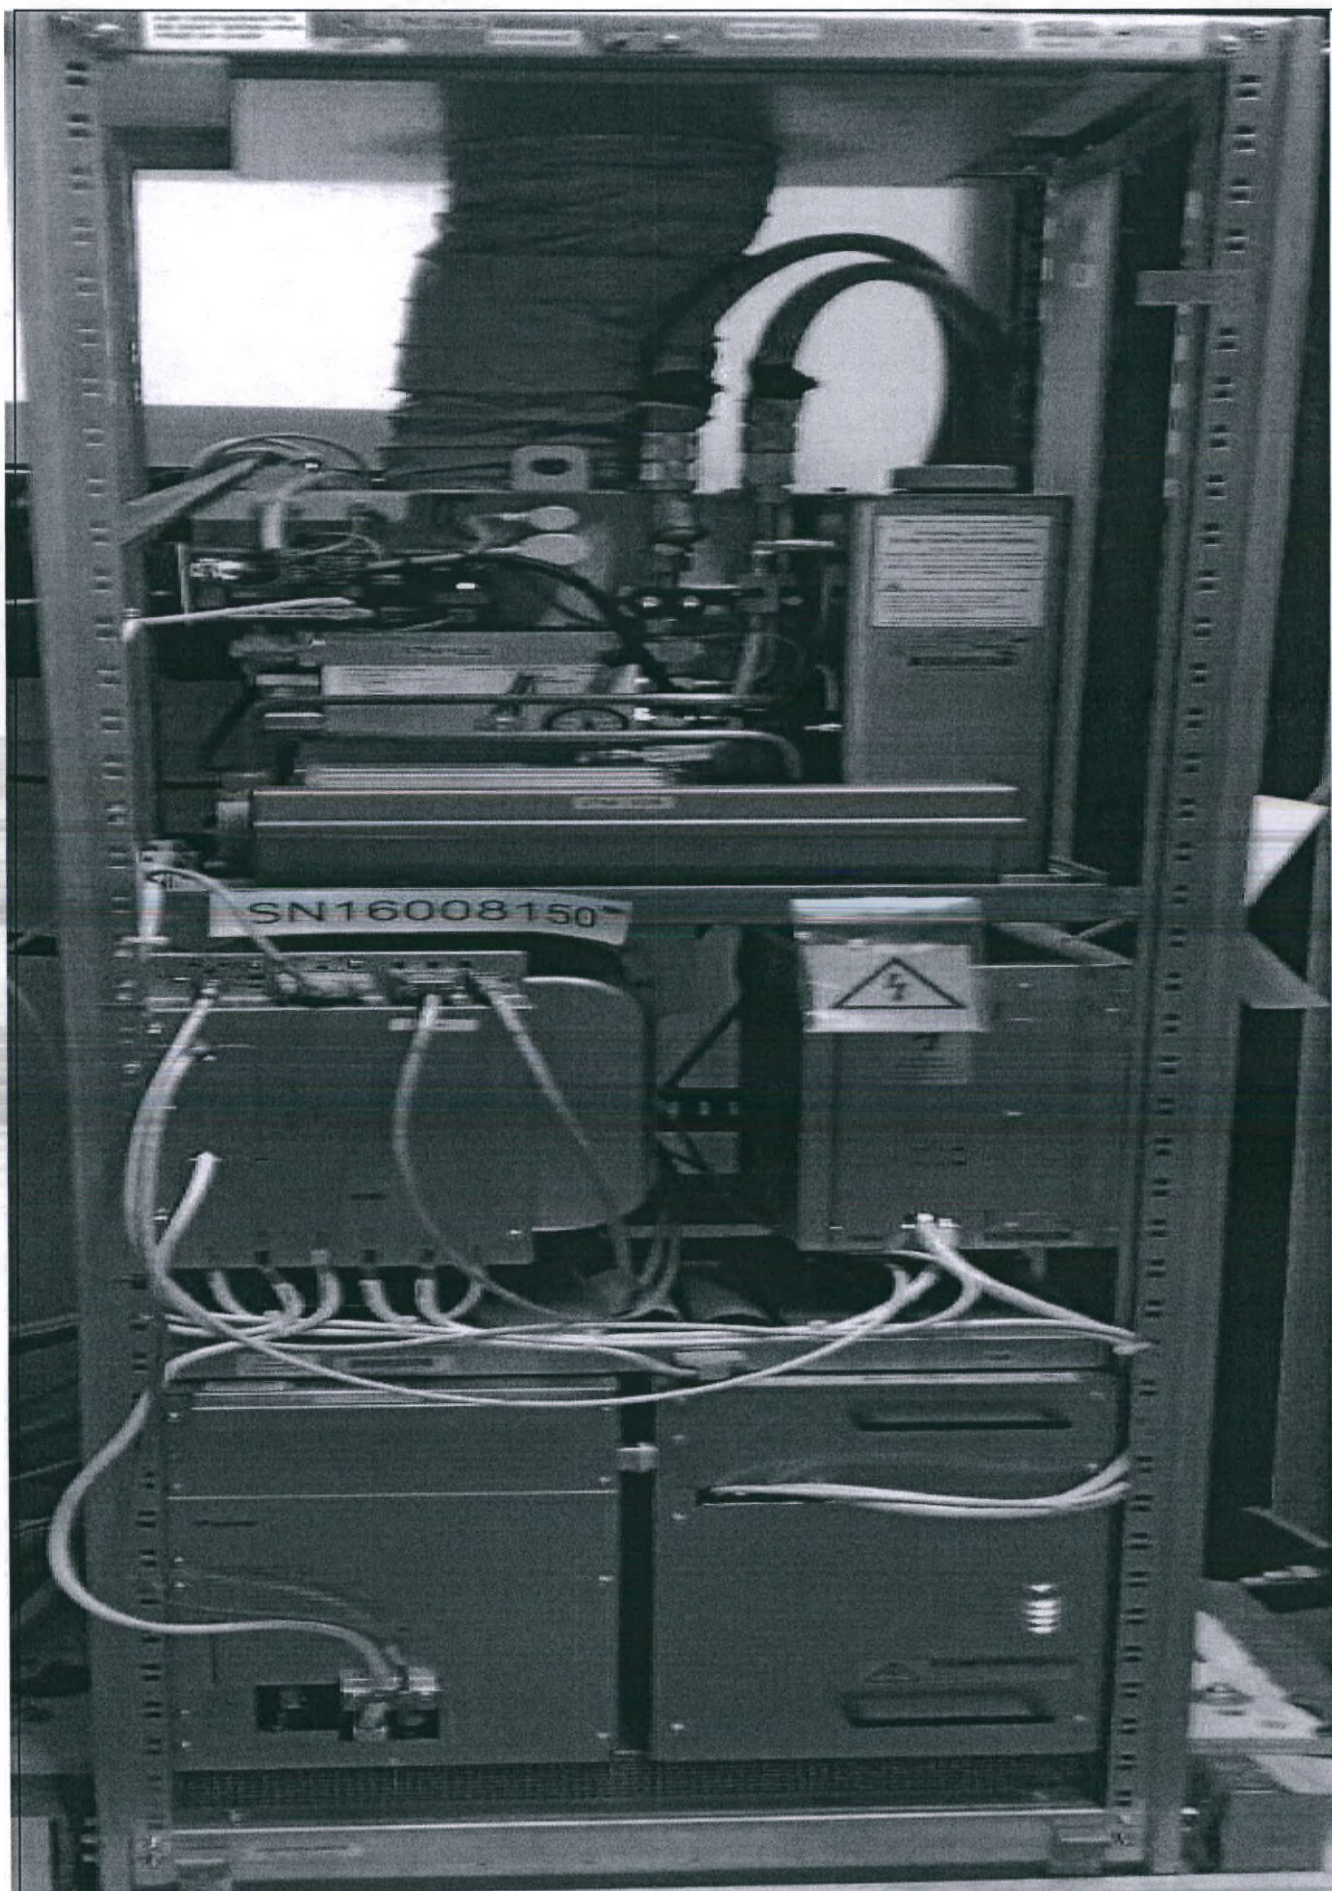


4.б. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

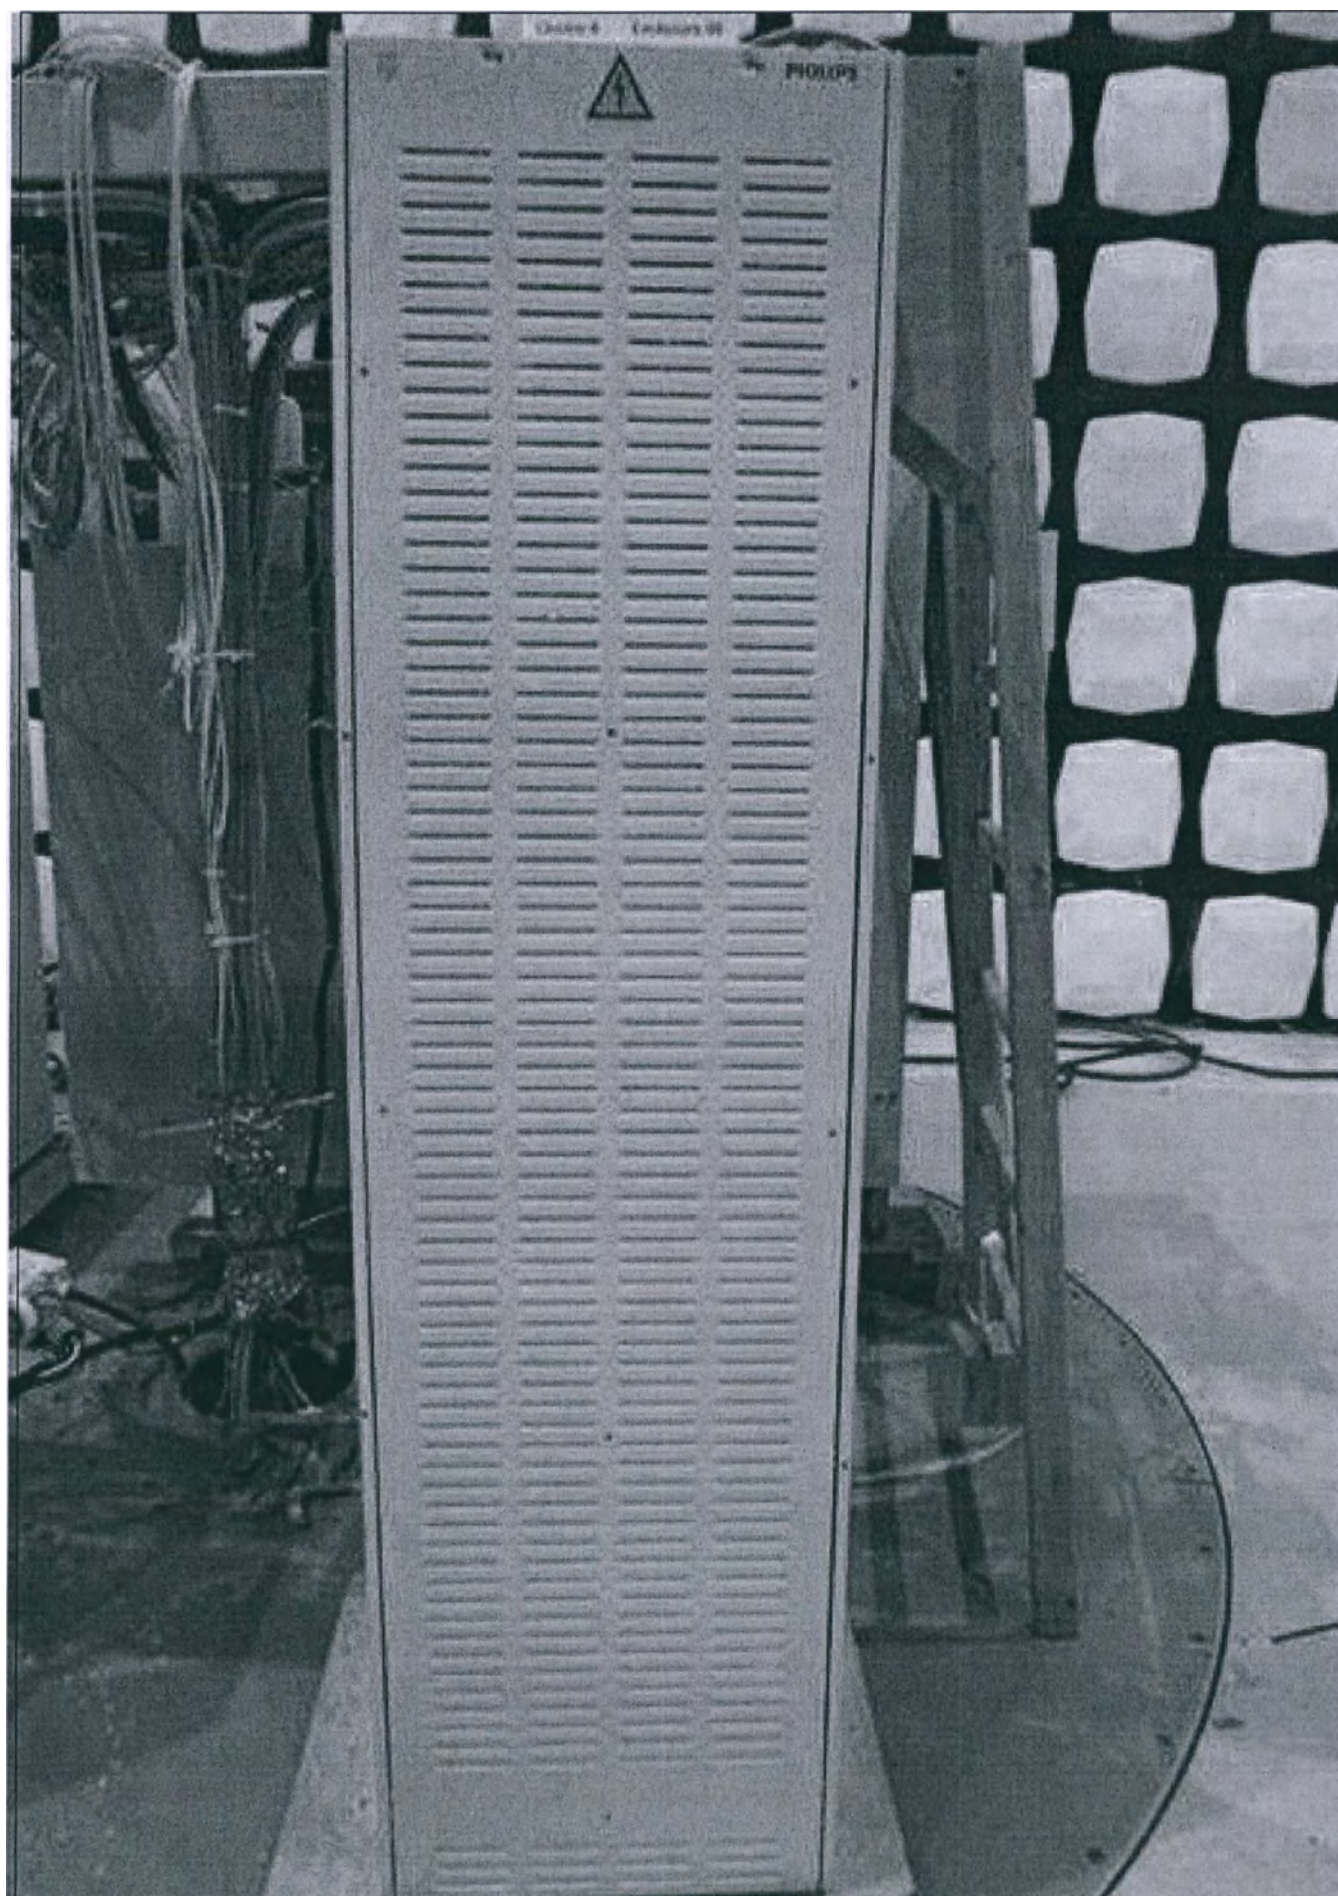


5.а. Шкаф управления.

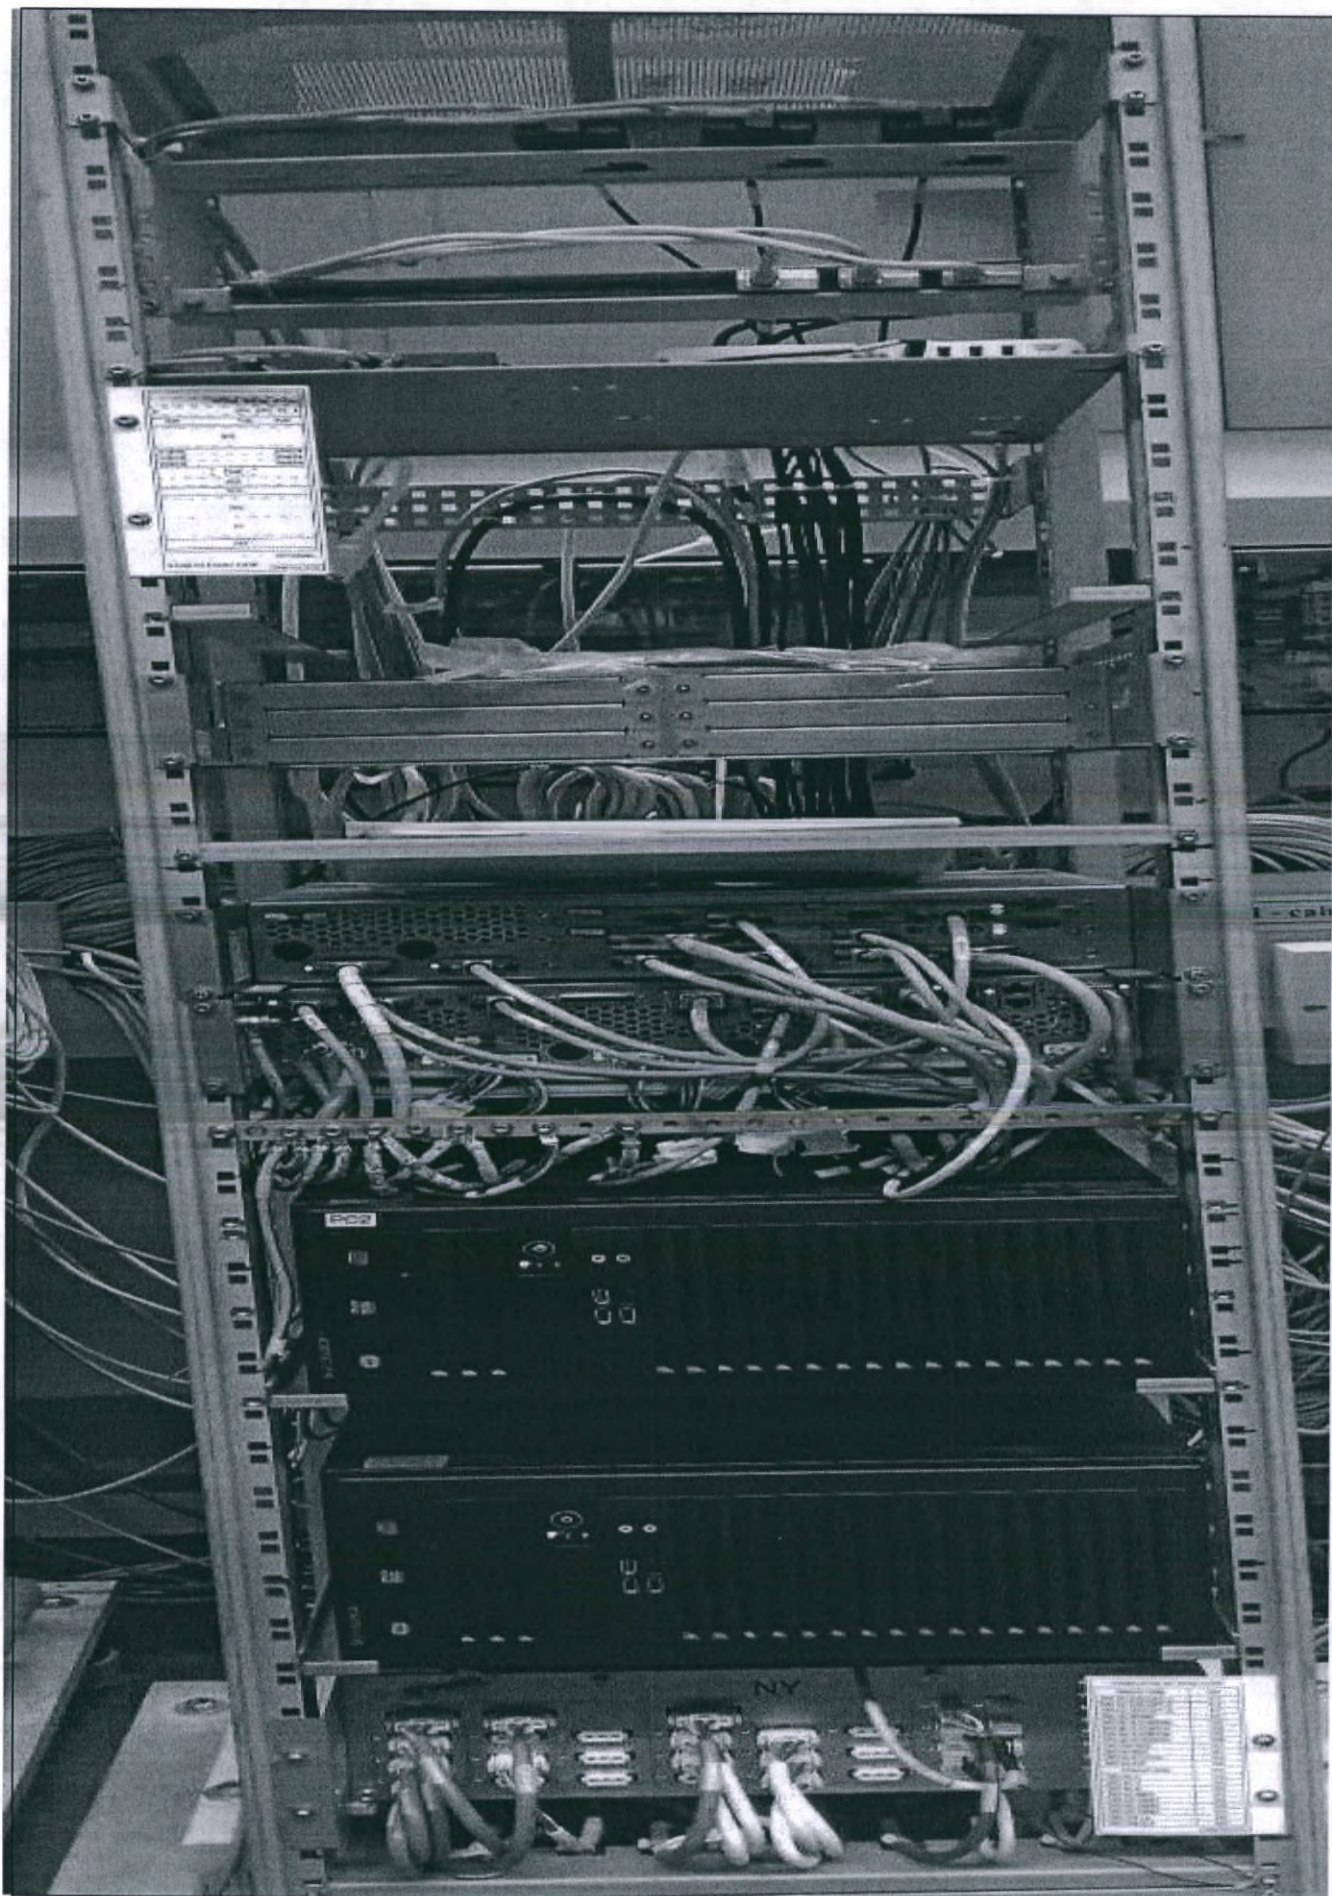

5.6. Шкаф управления.

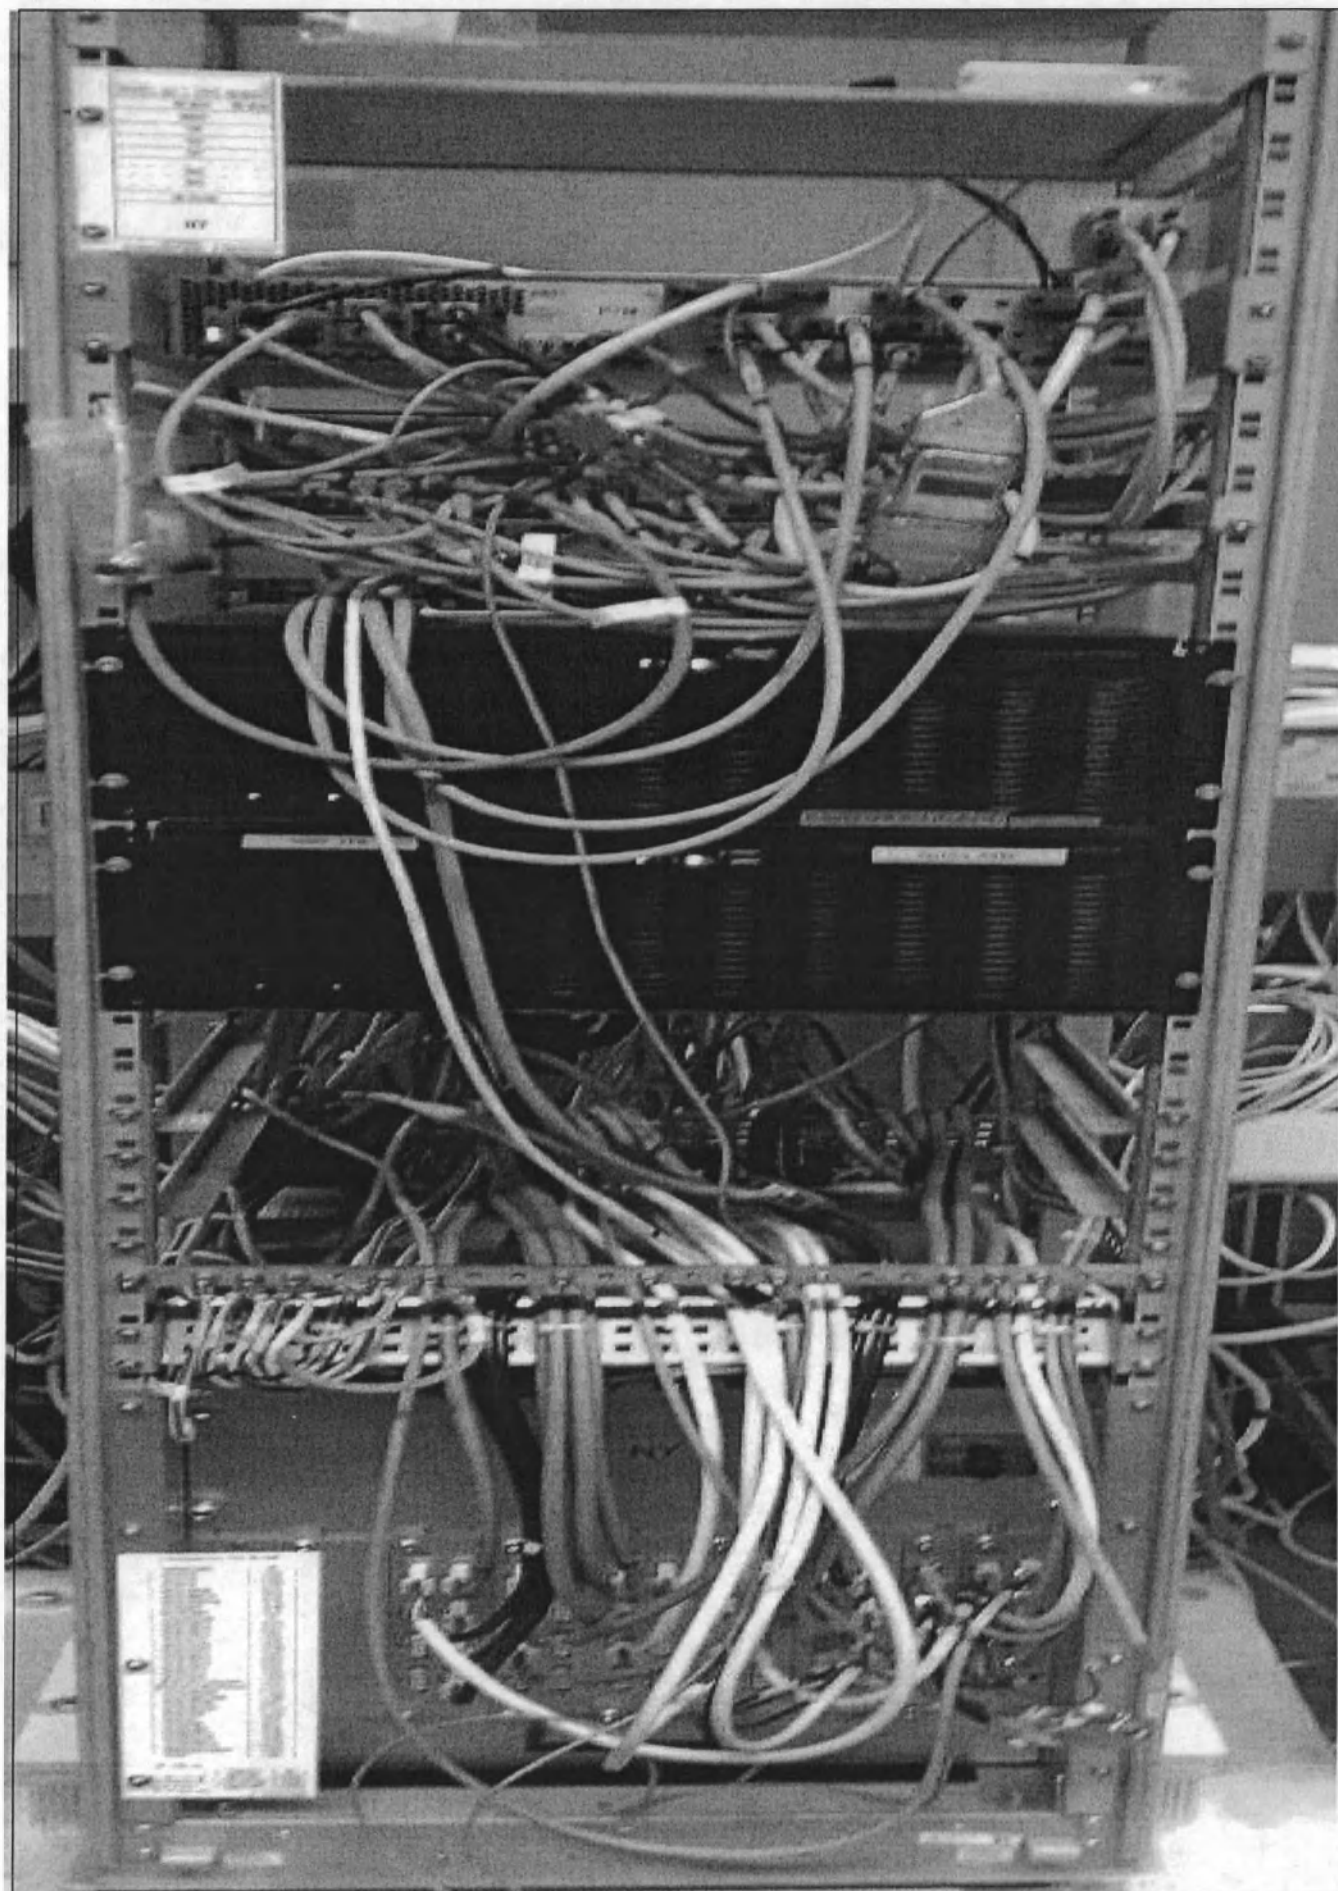


б.а. Распределительный щит.

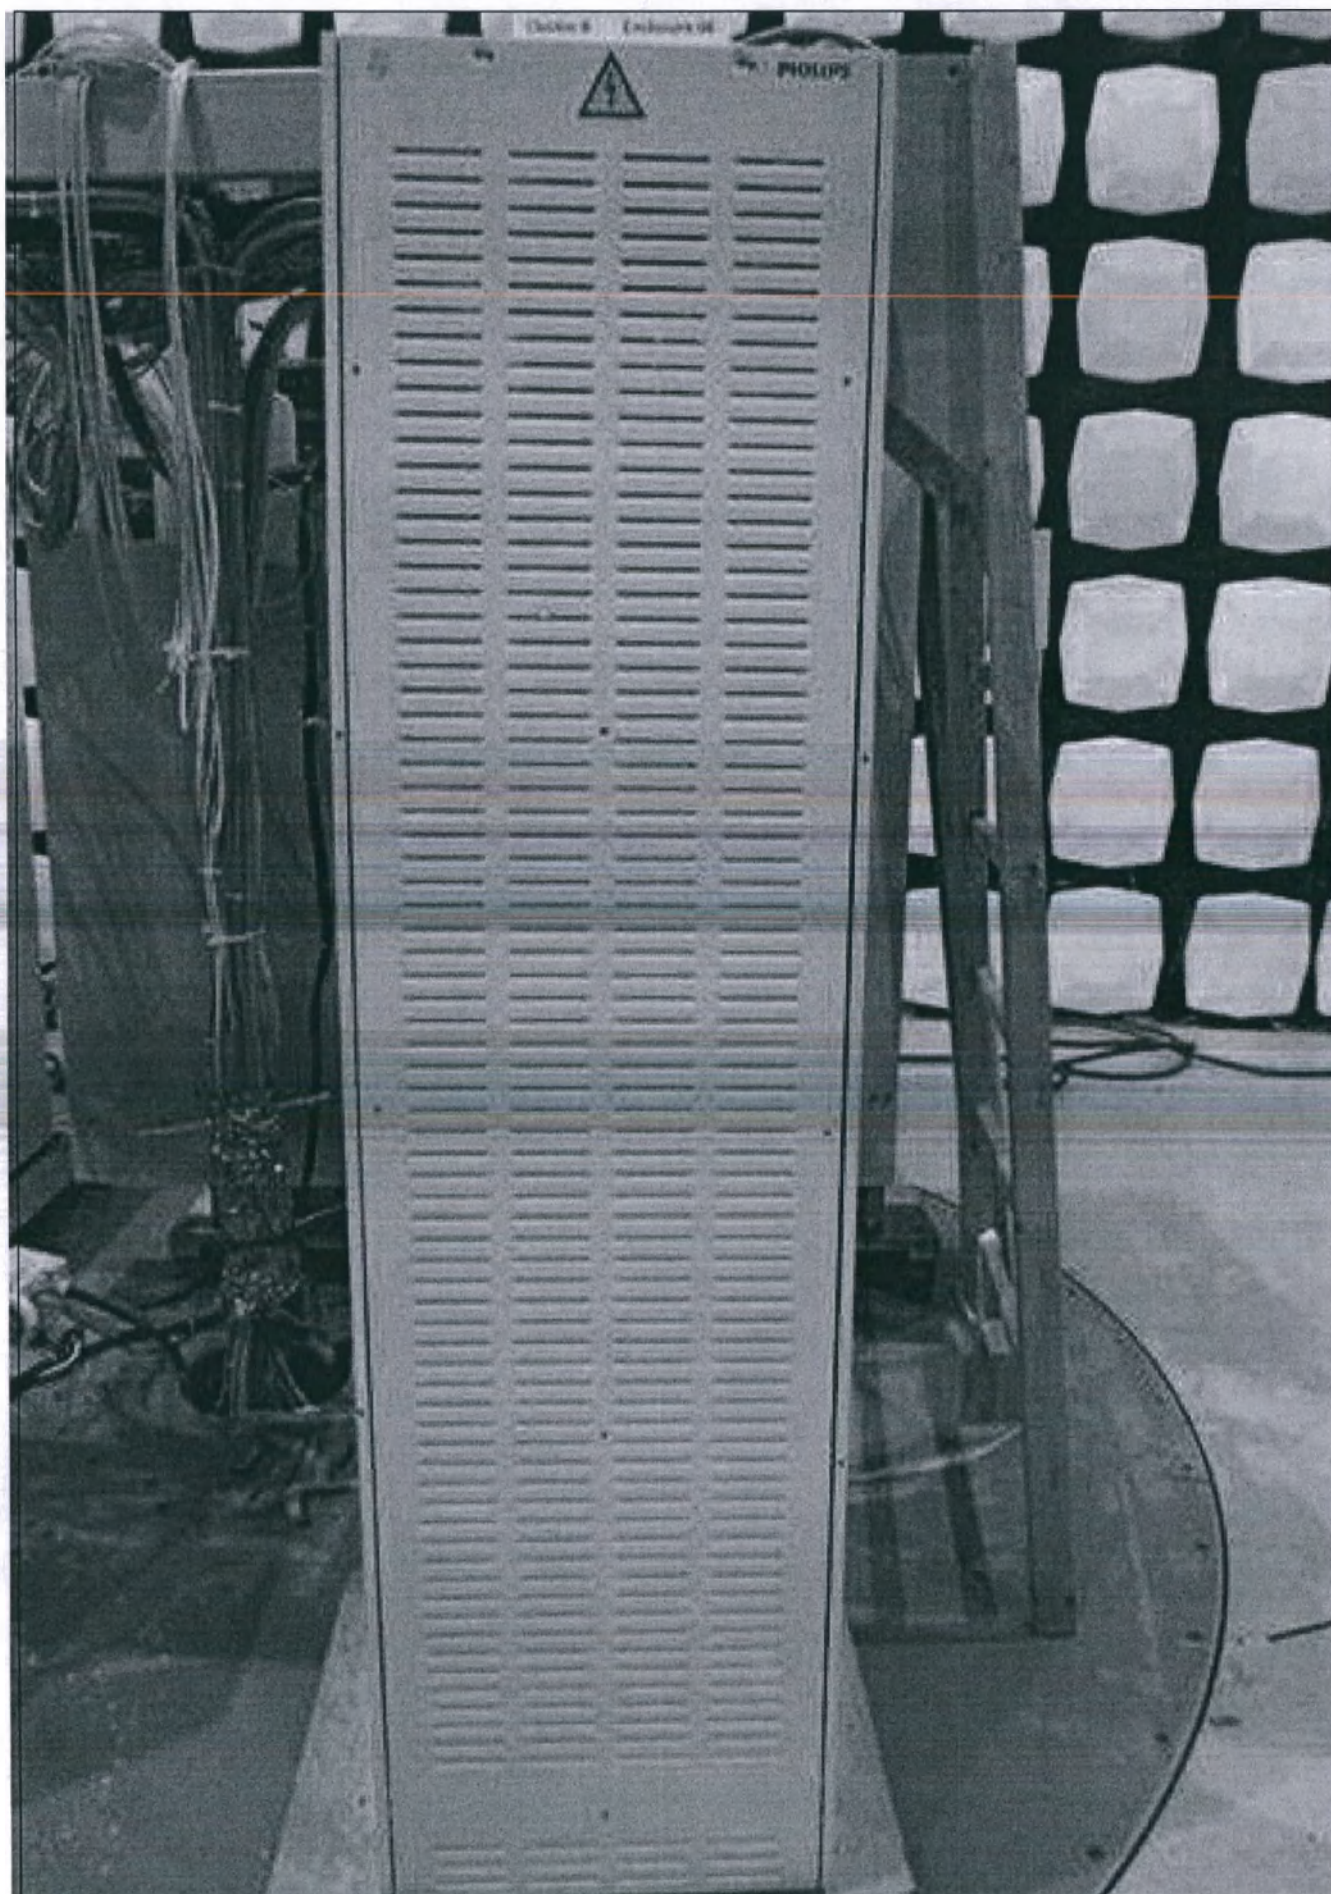


6.6. Распределительный щит.




7. Модуль сенсорного экрана, не более 2 шт.

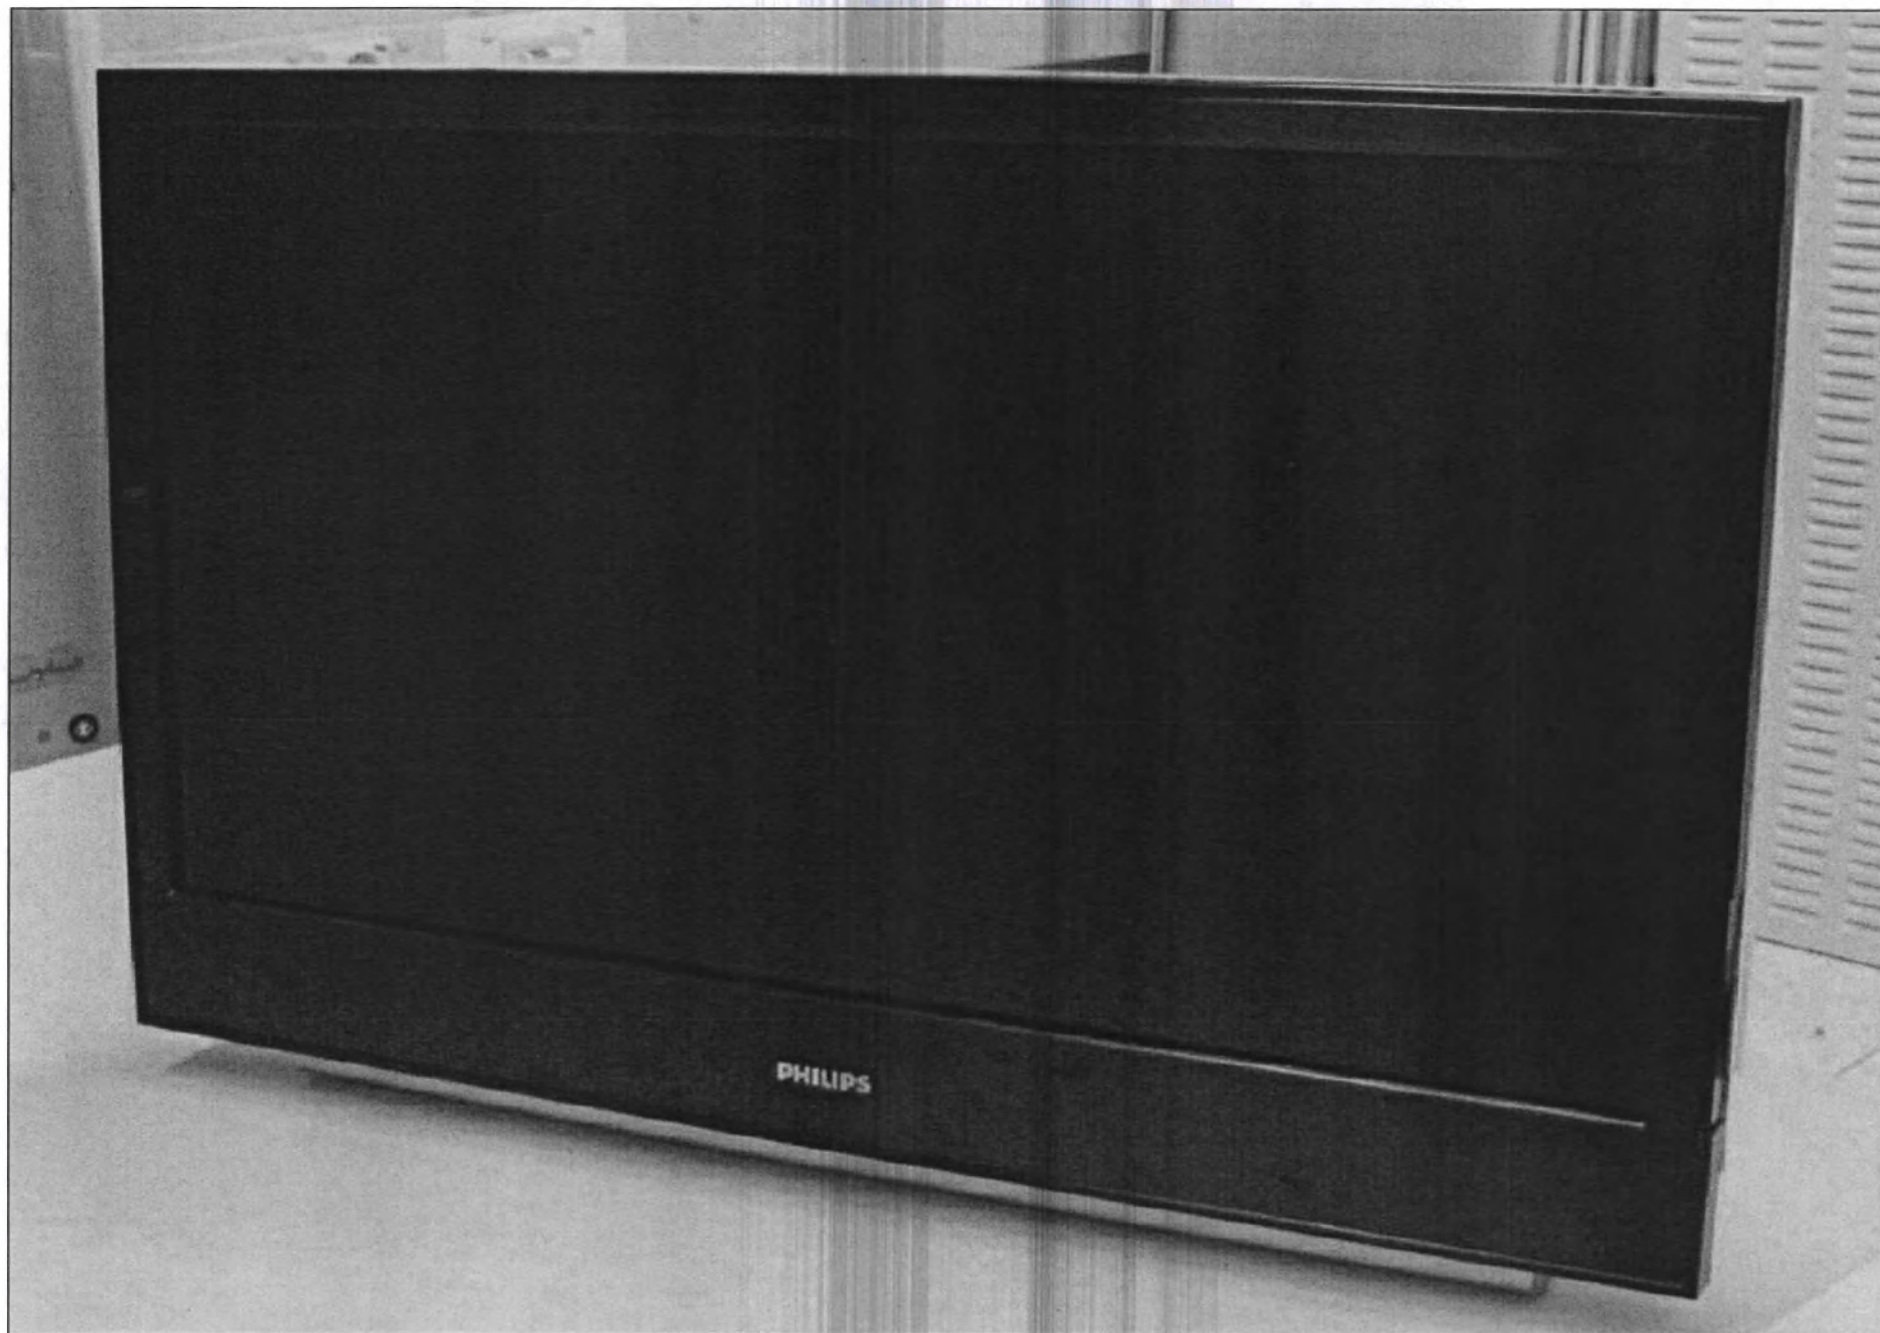

8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

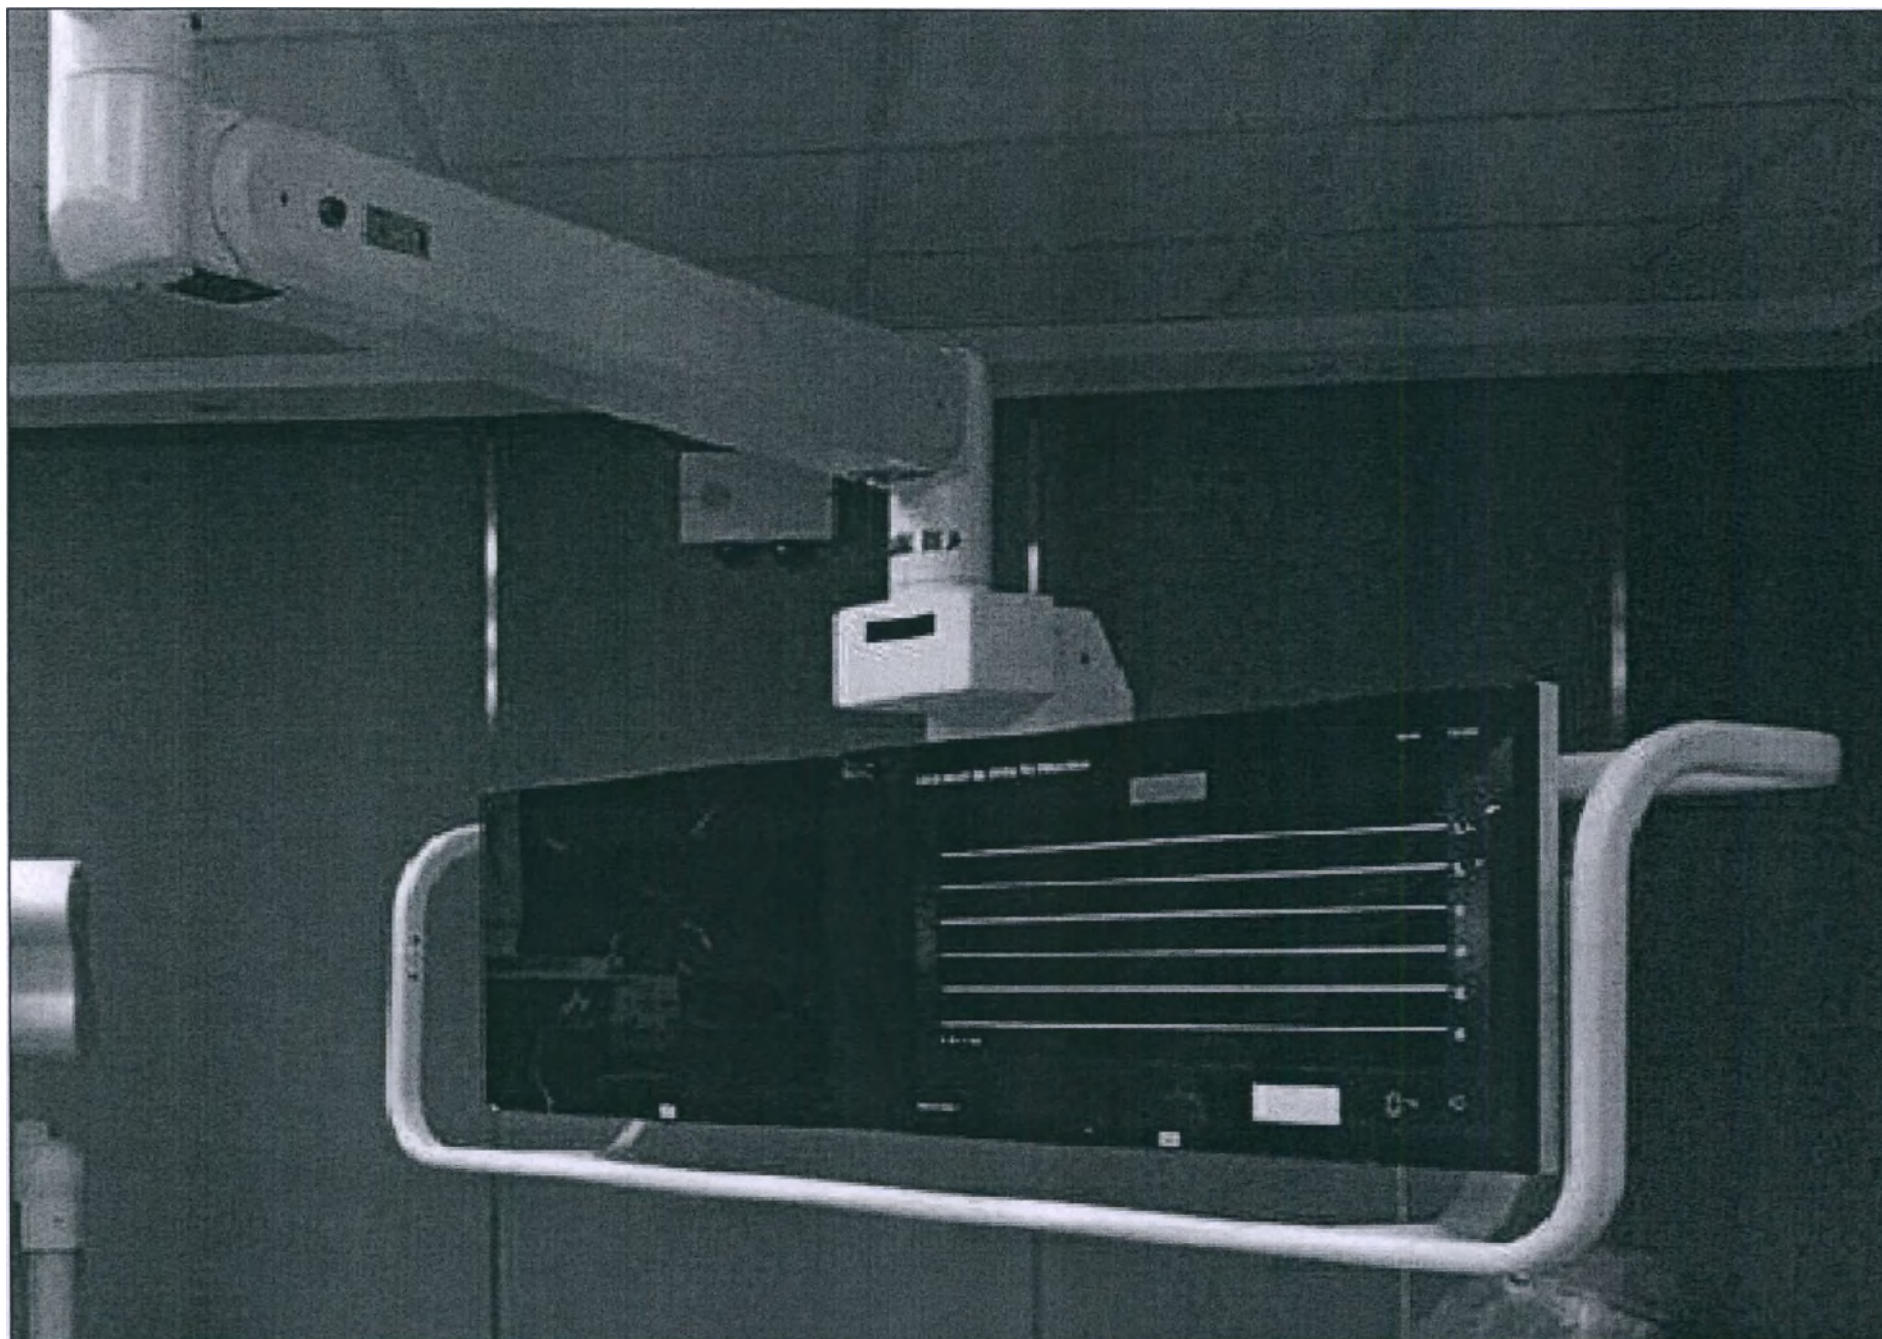


9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

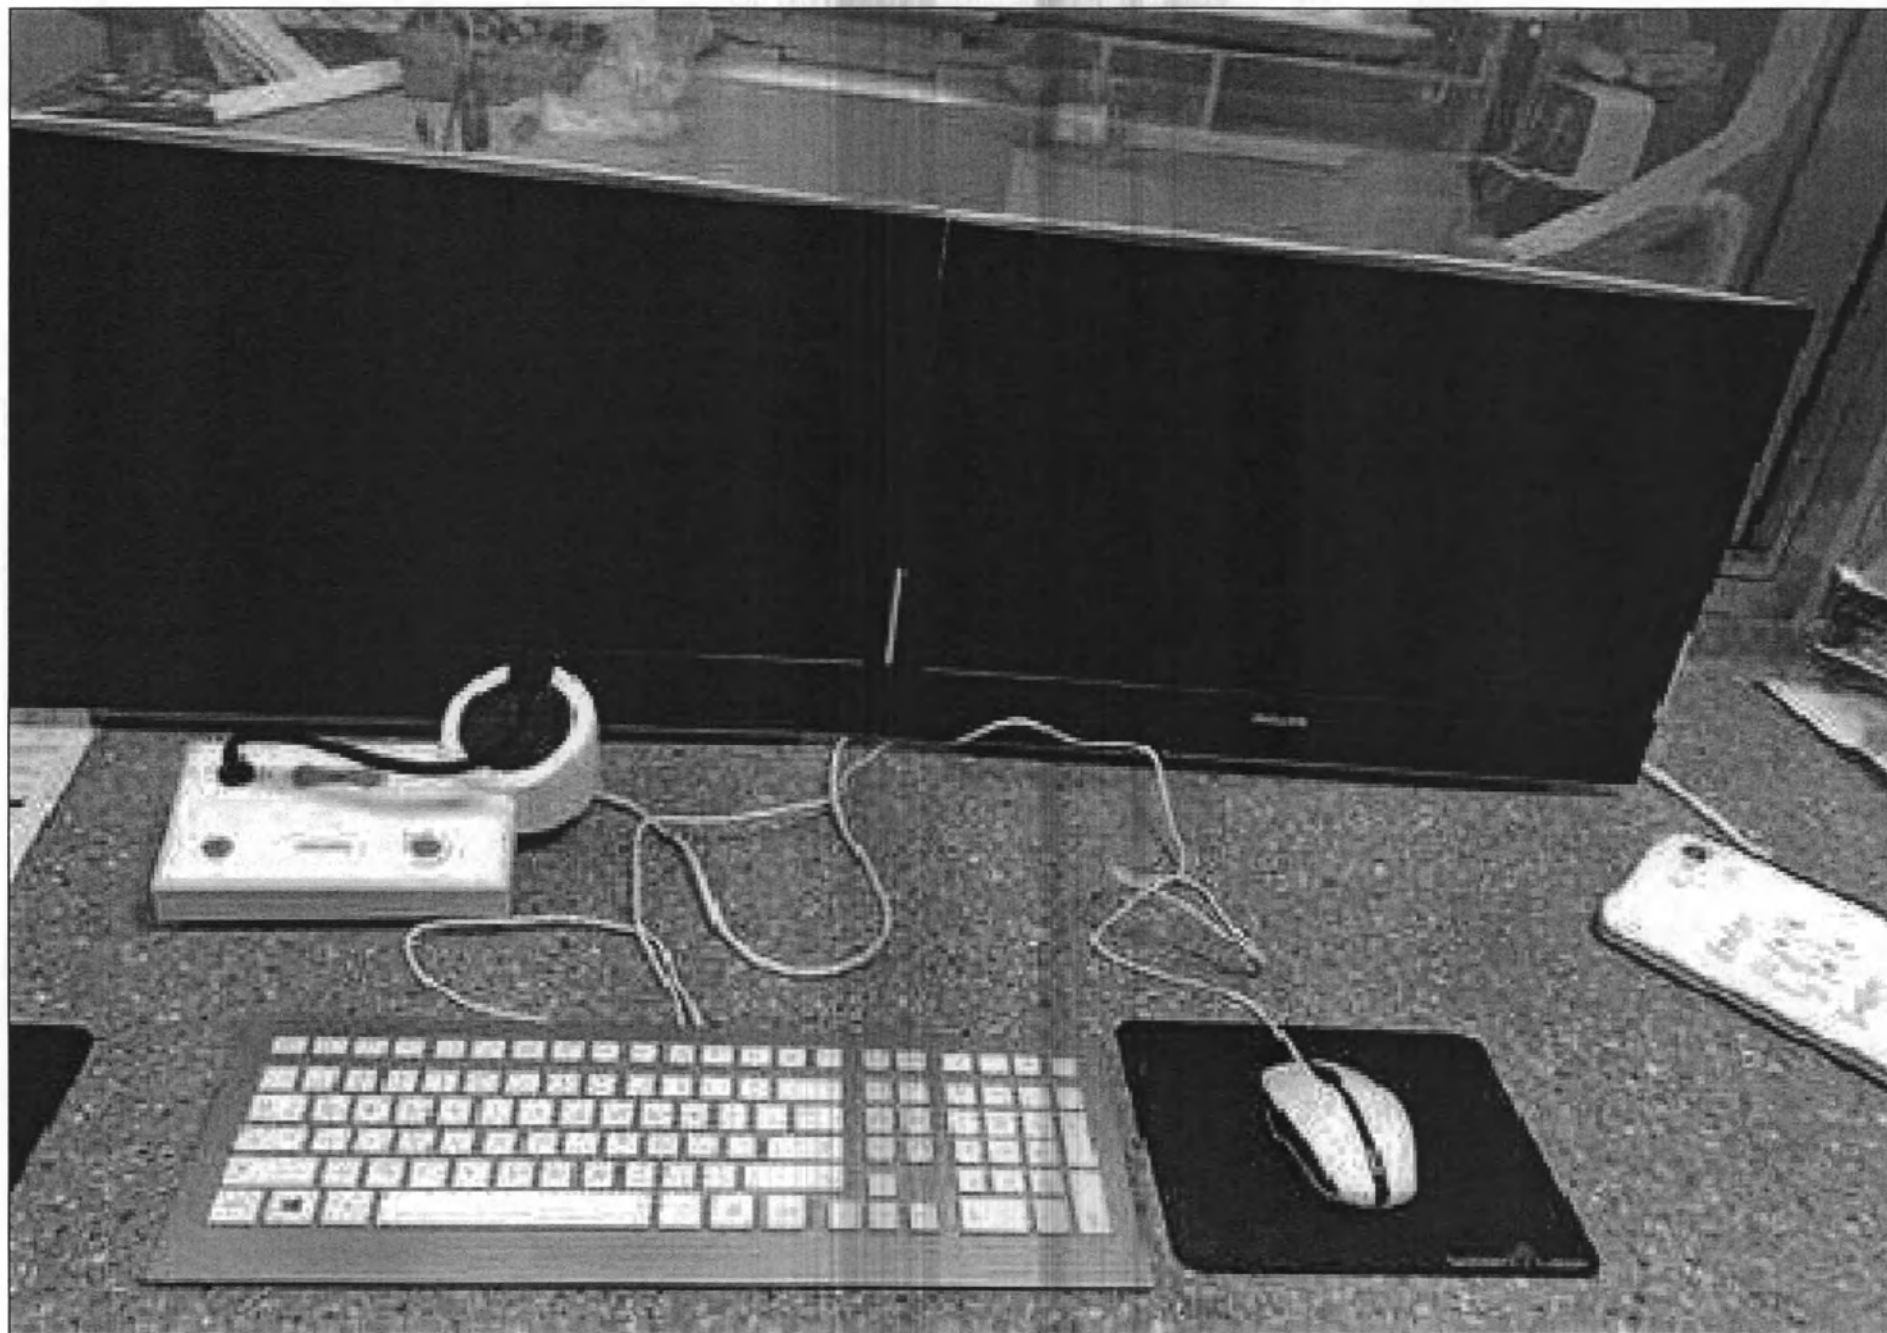


10.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.




10.6. Оборудование пультовой в составе: **Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.**

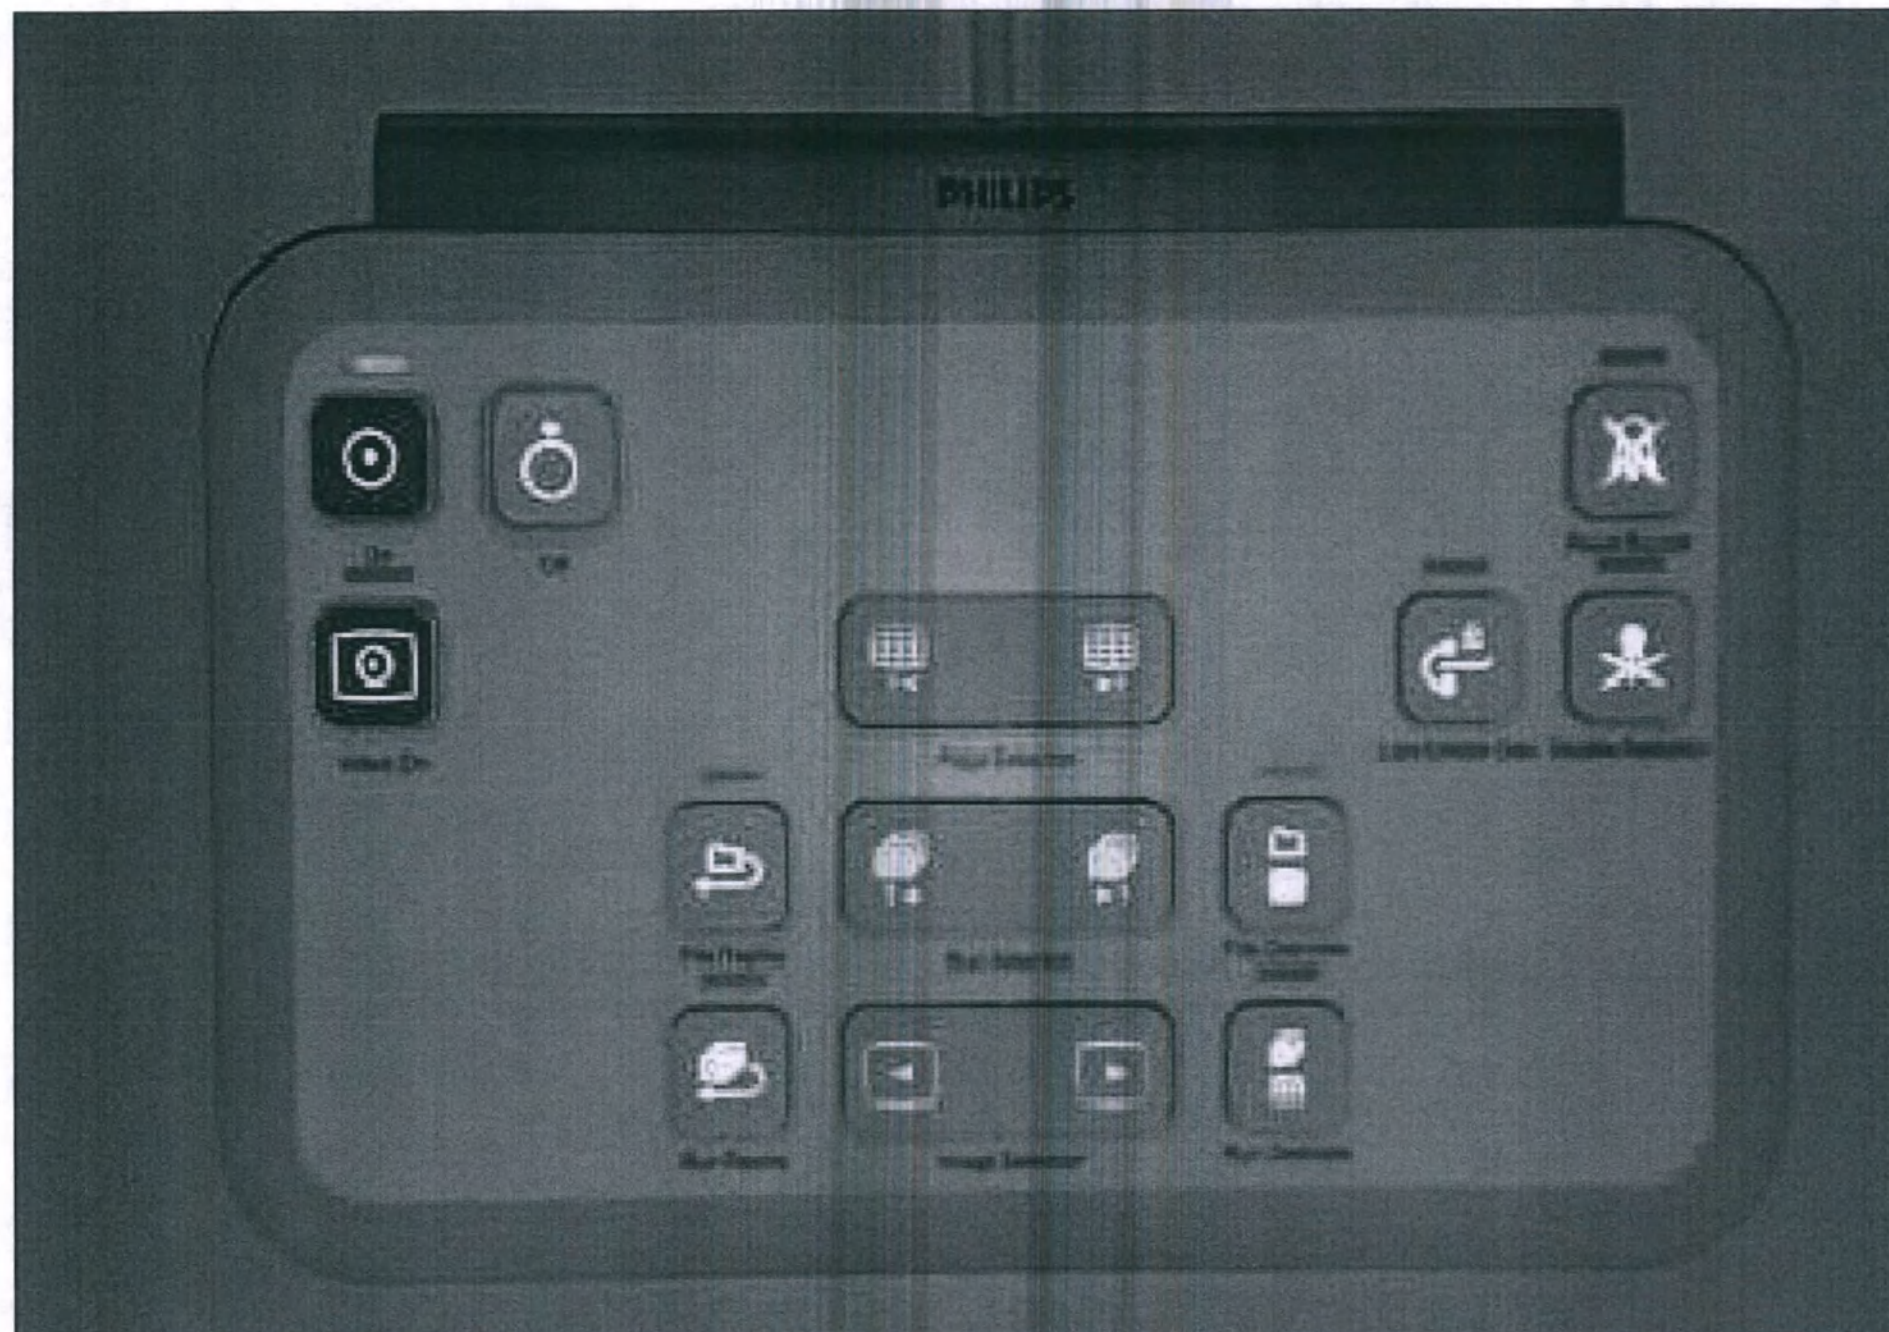


10.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

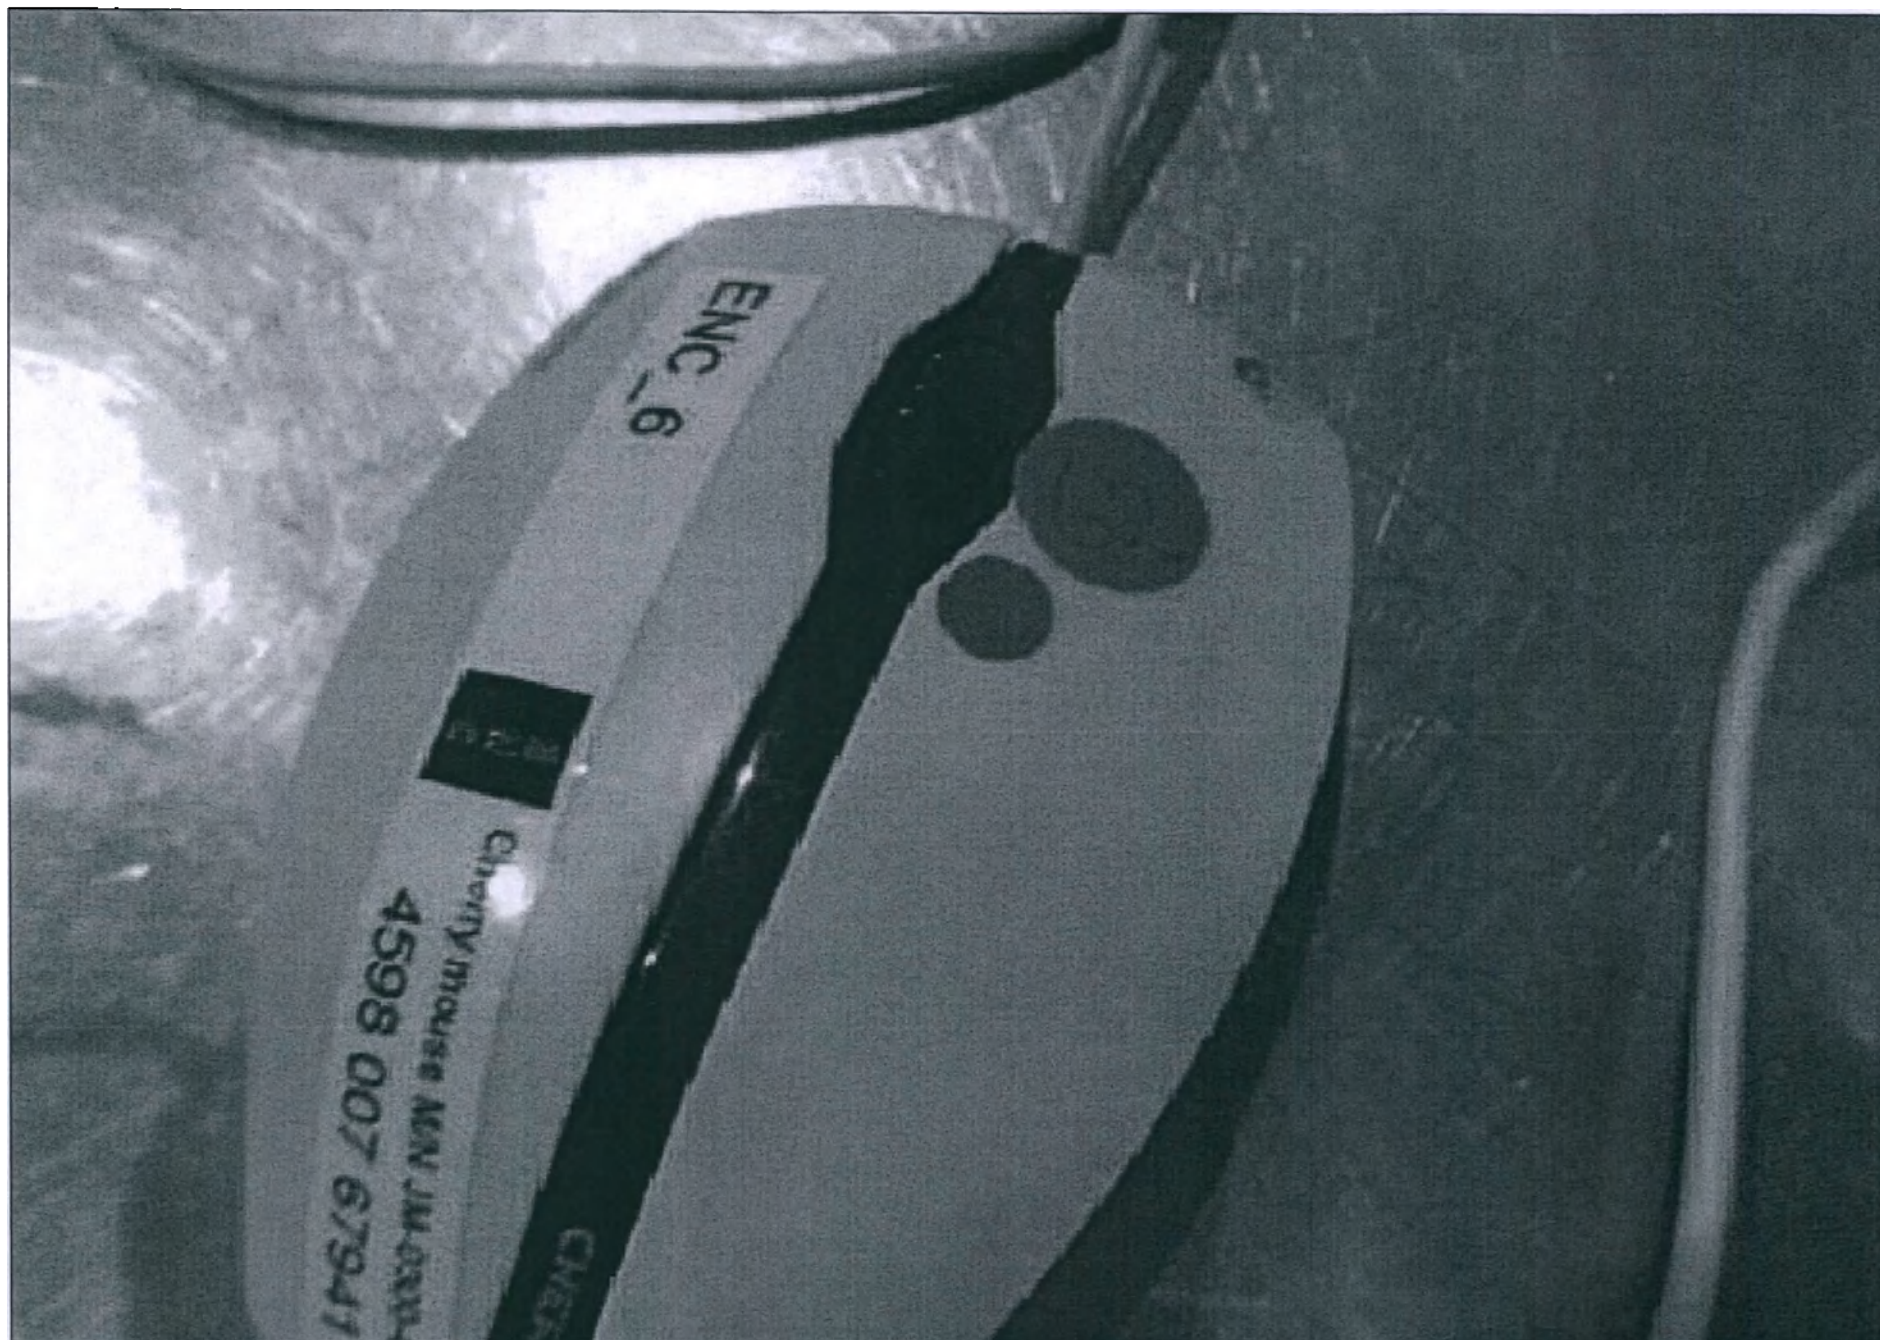


10.2. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

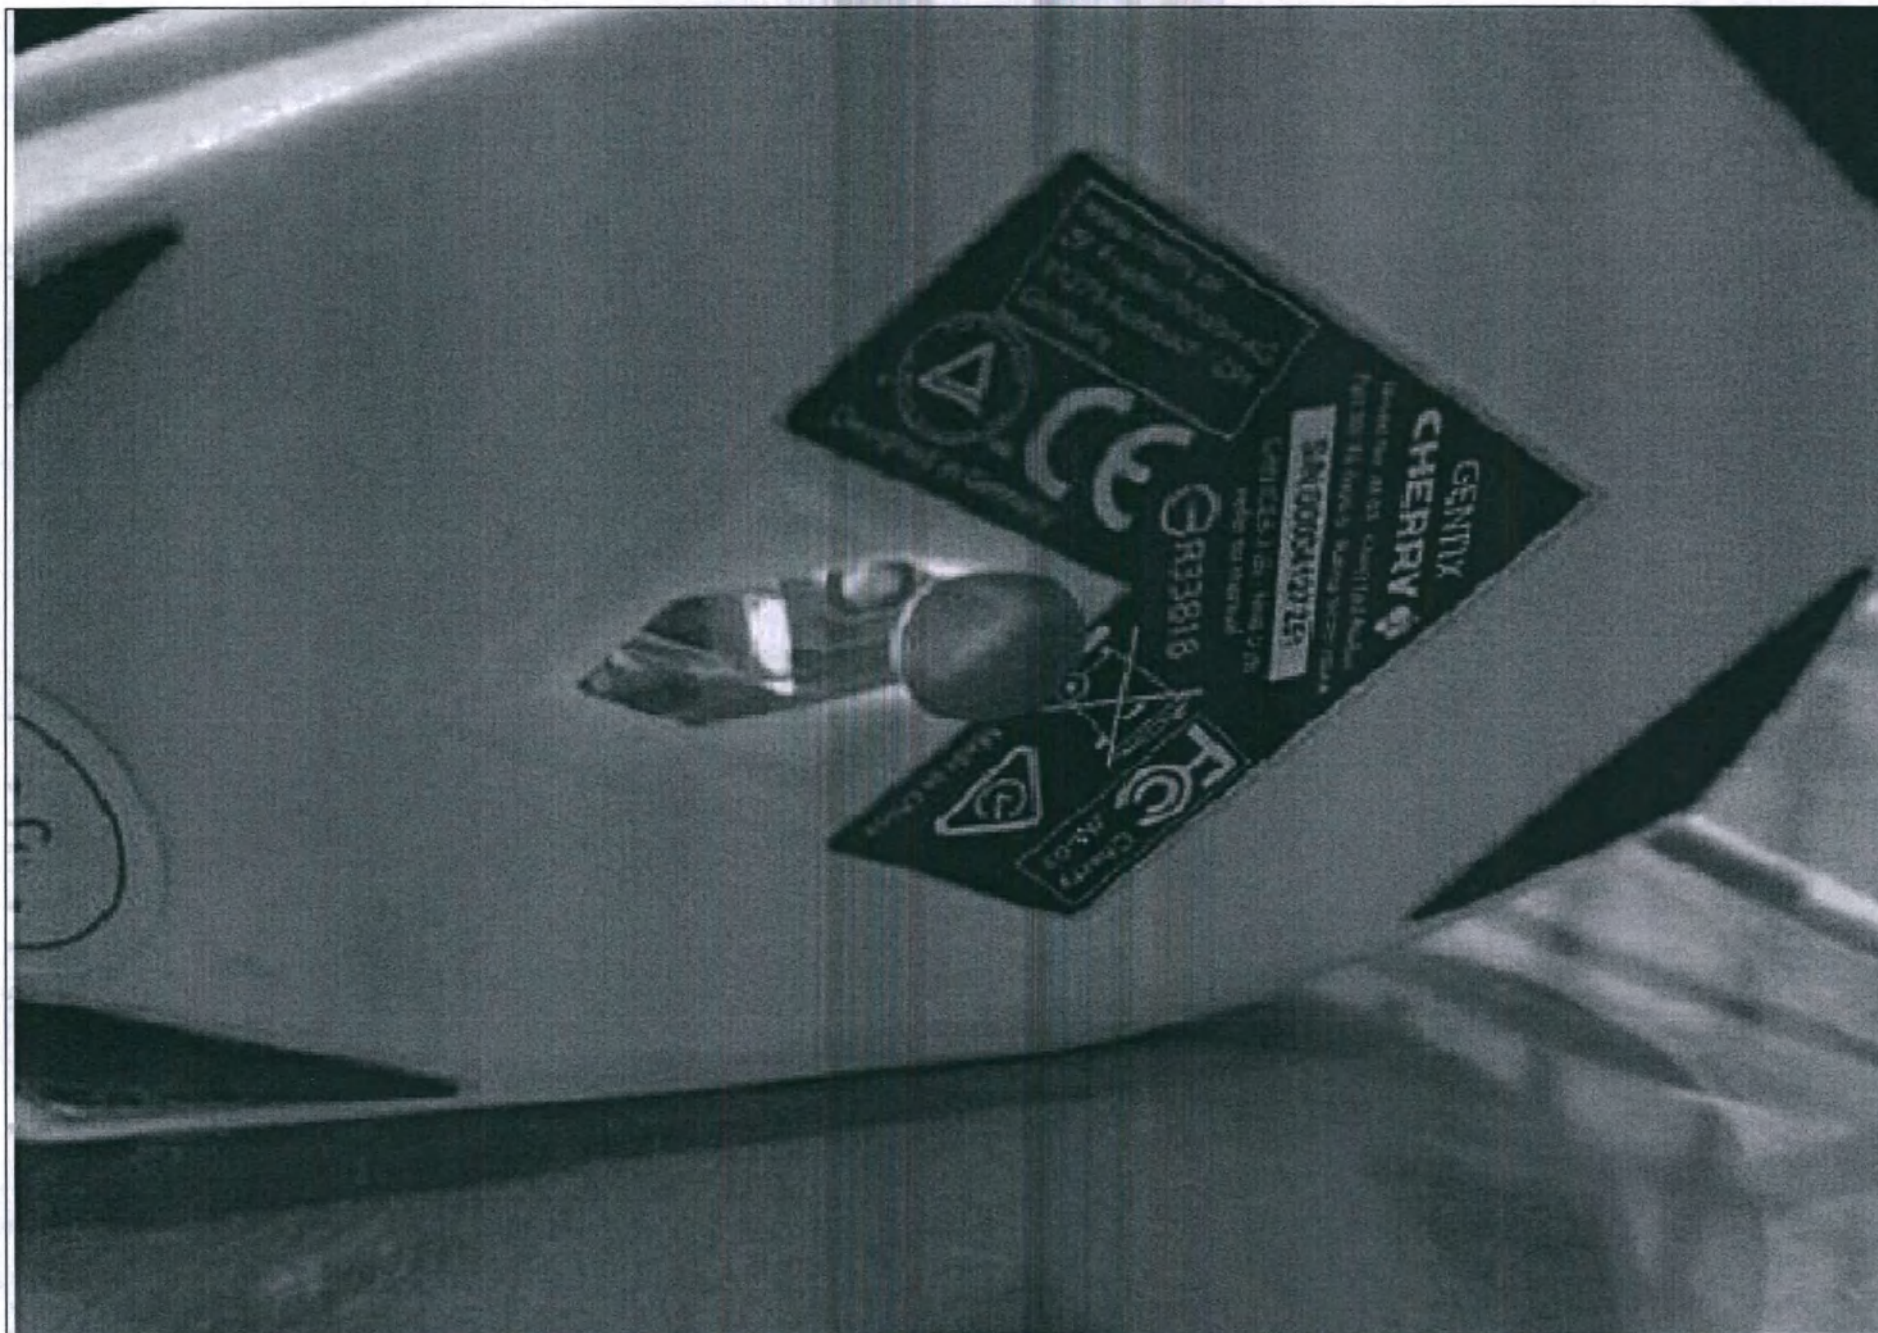


10.д. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

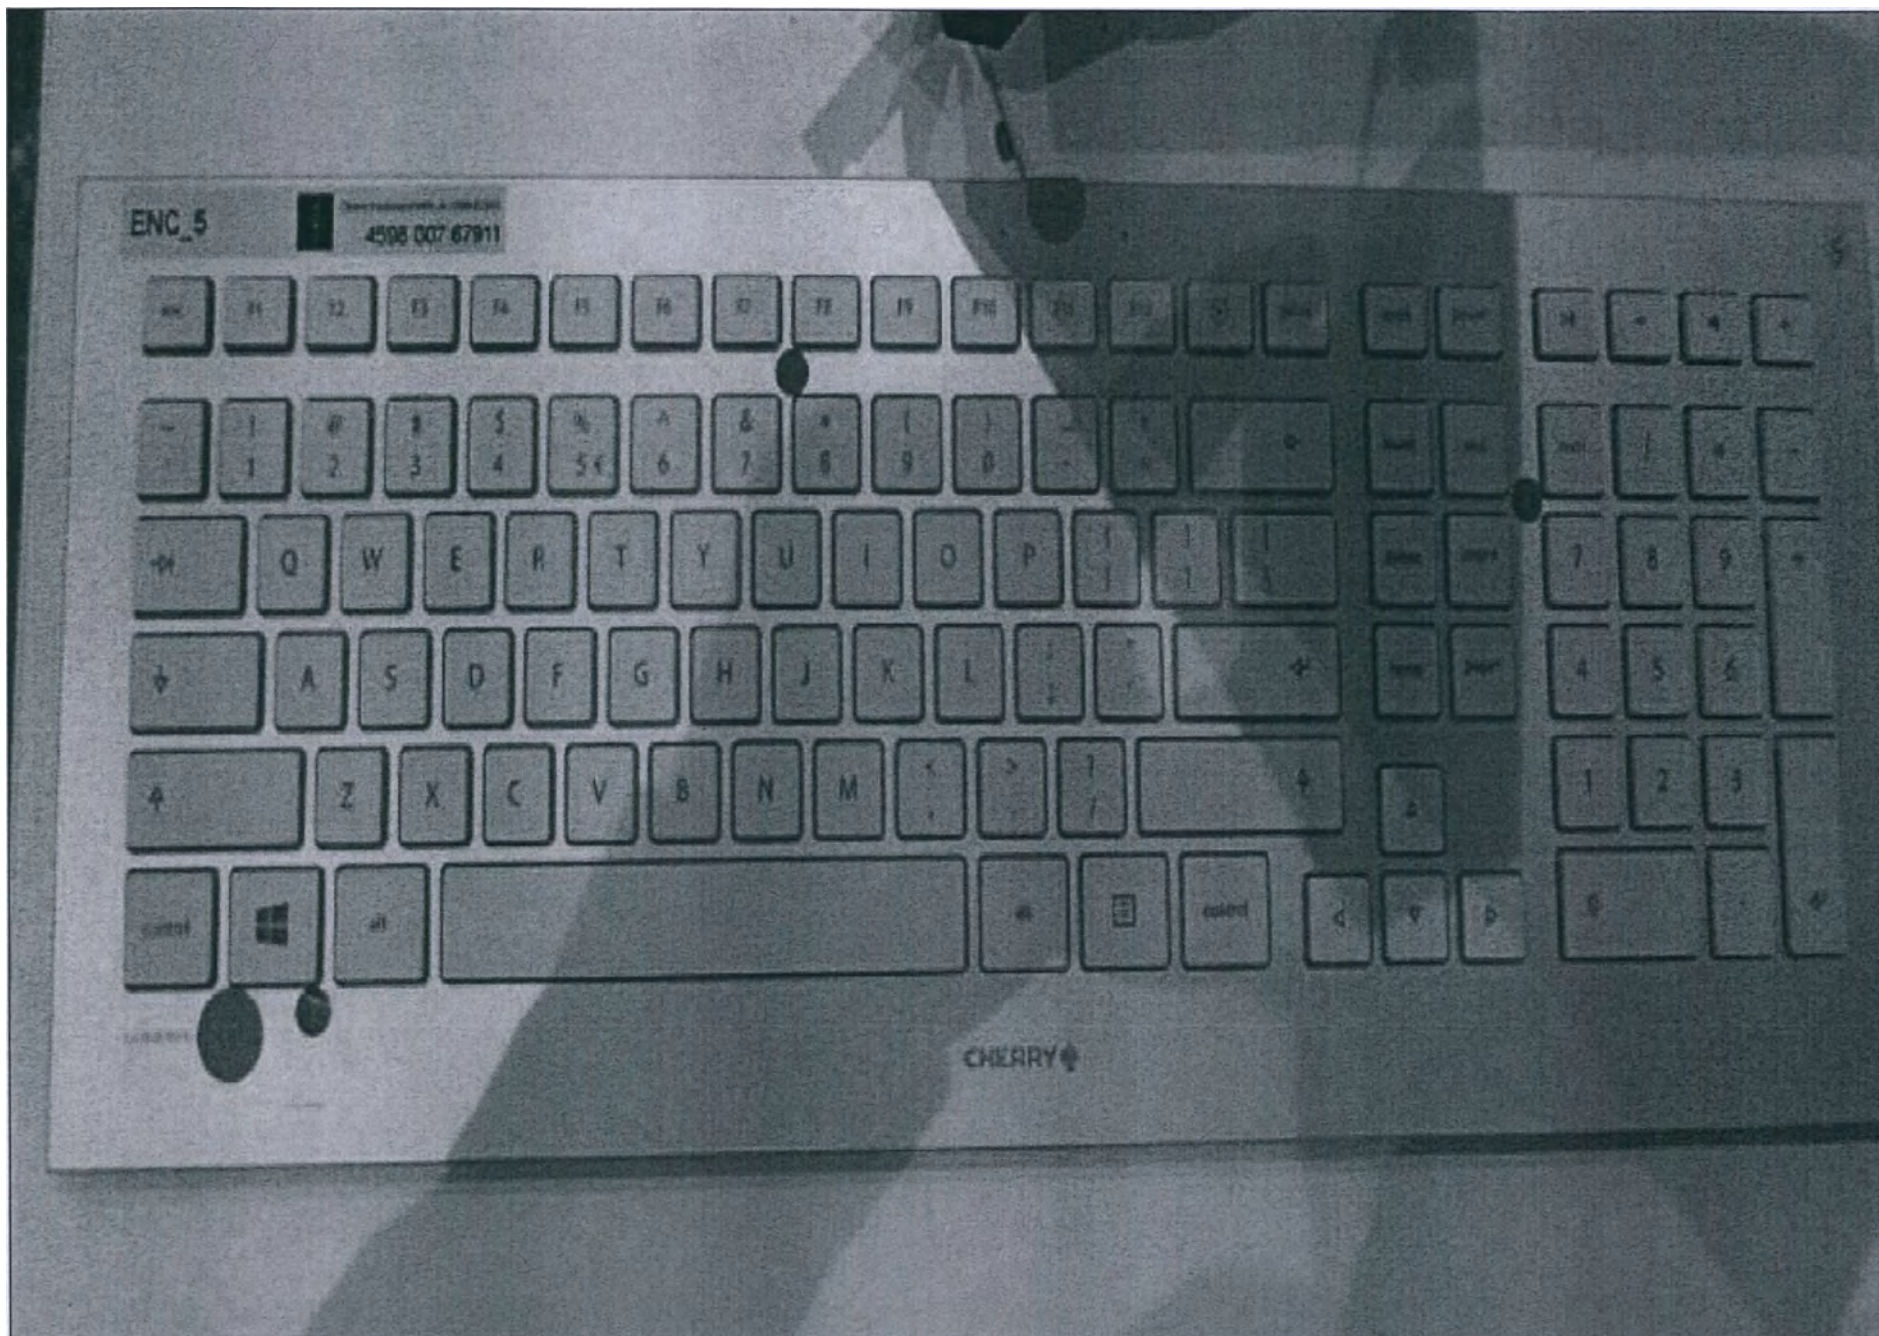


10.e. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

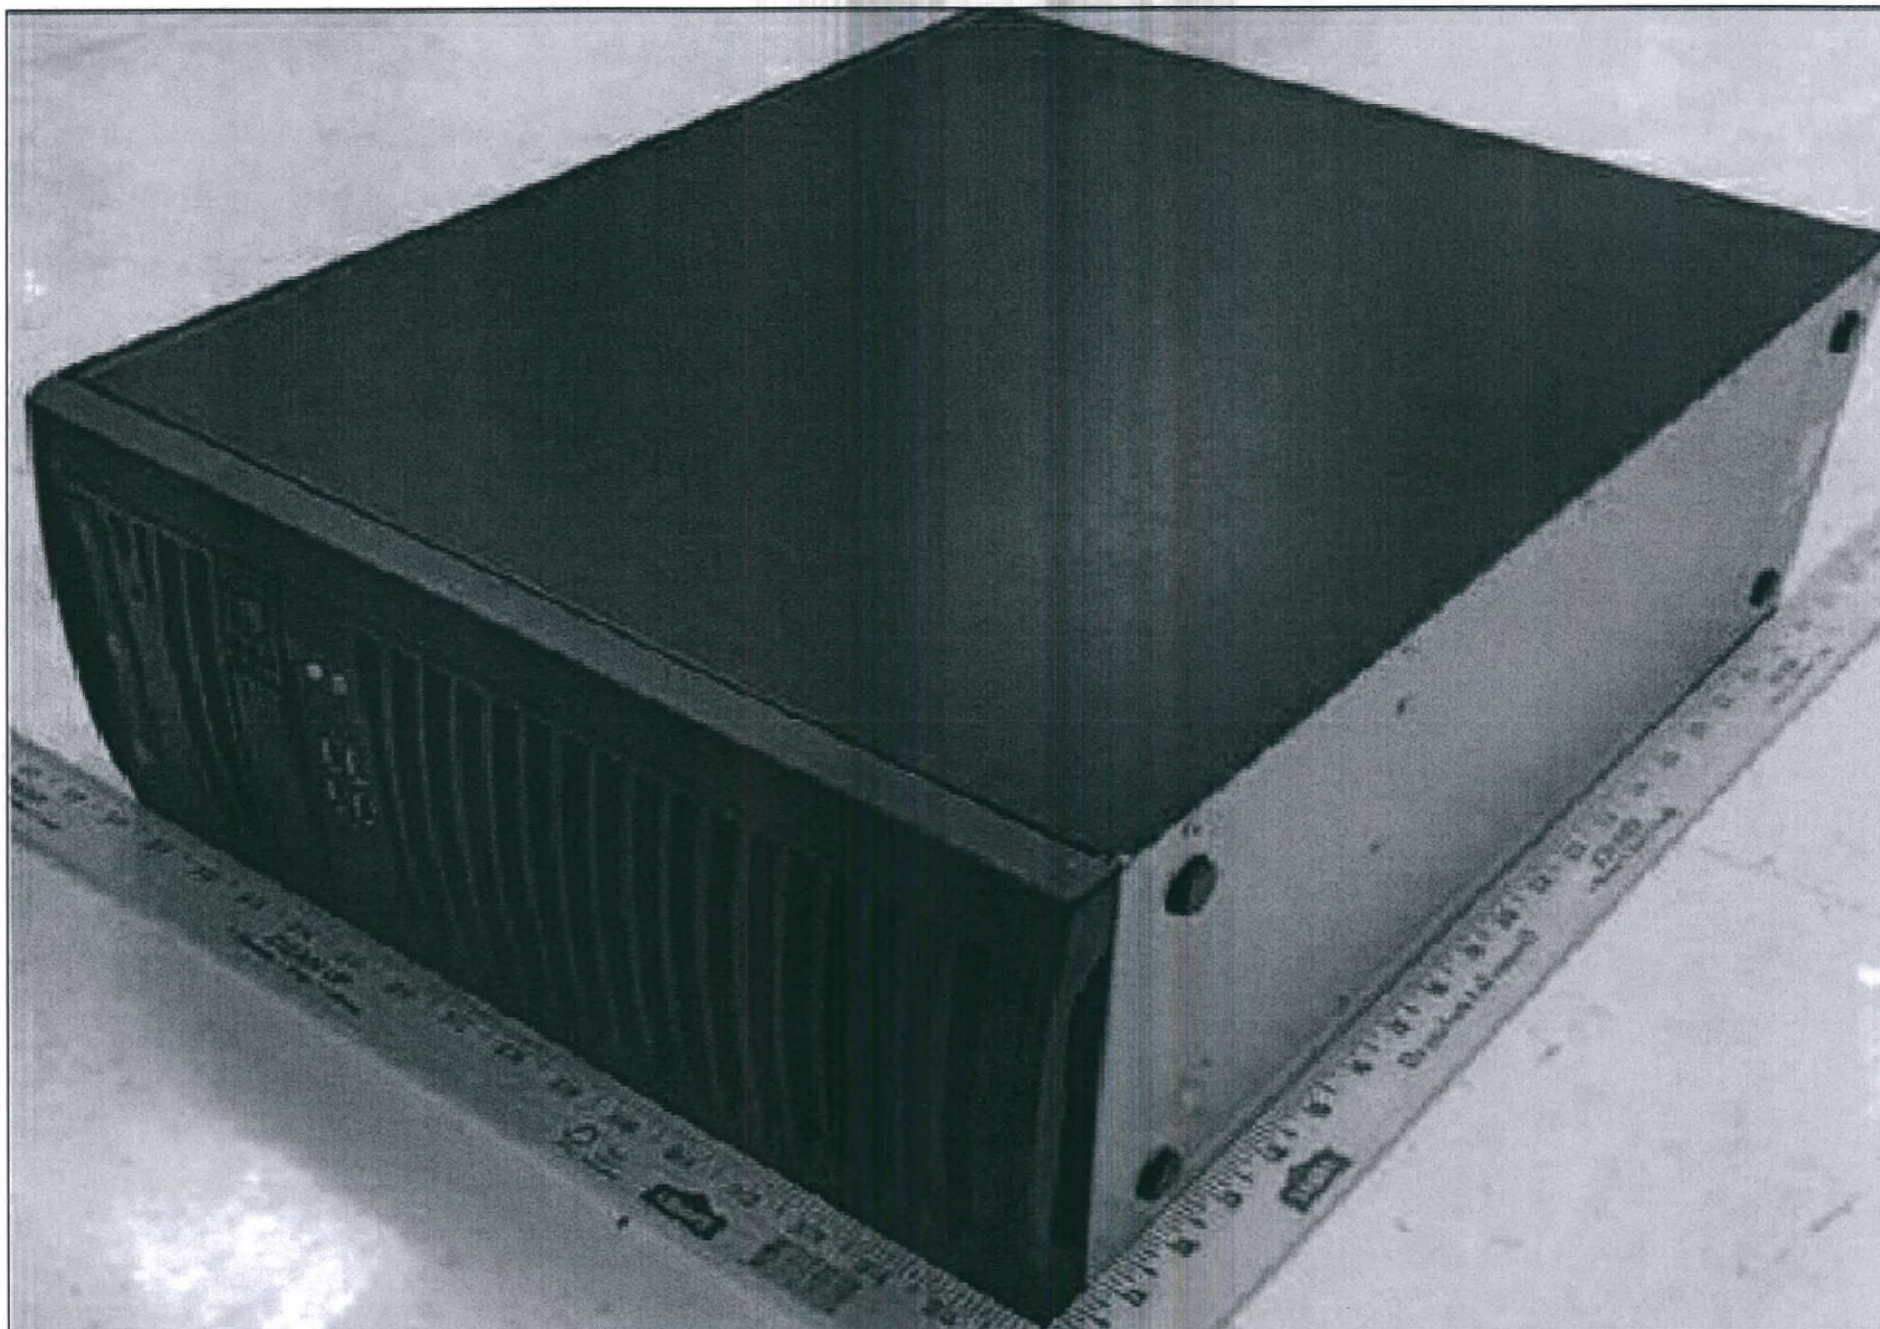


10.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

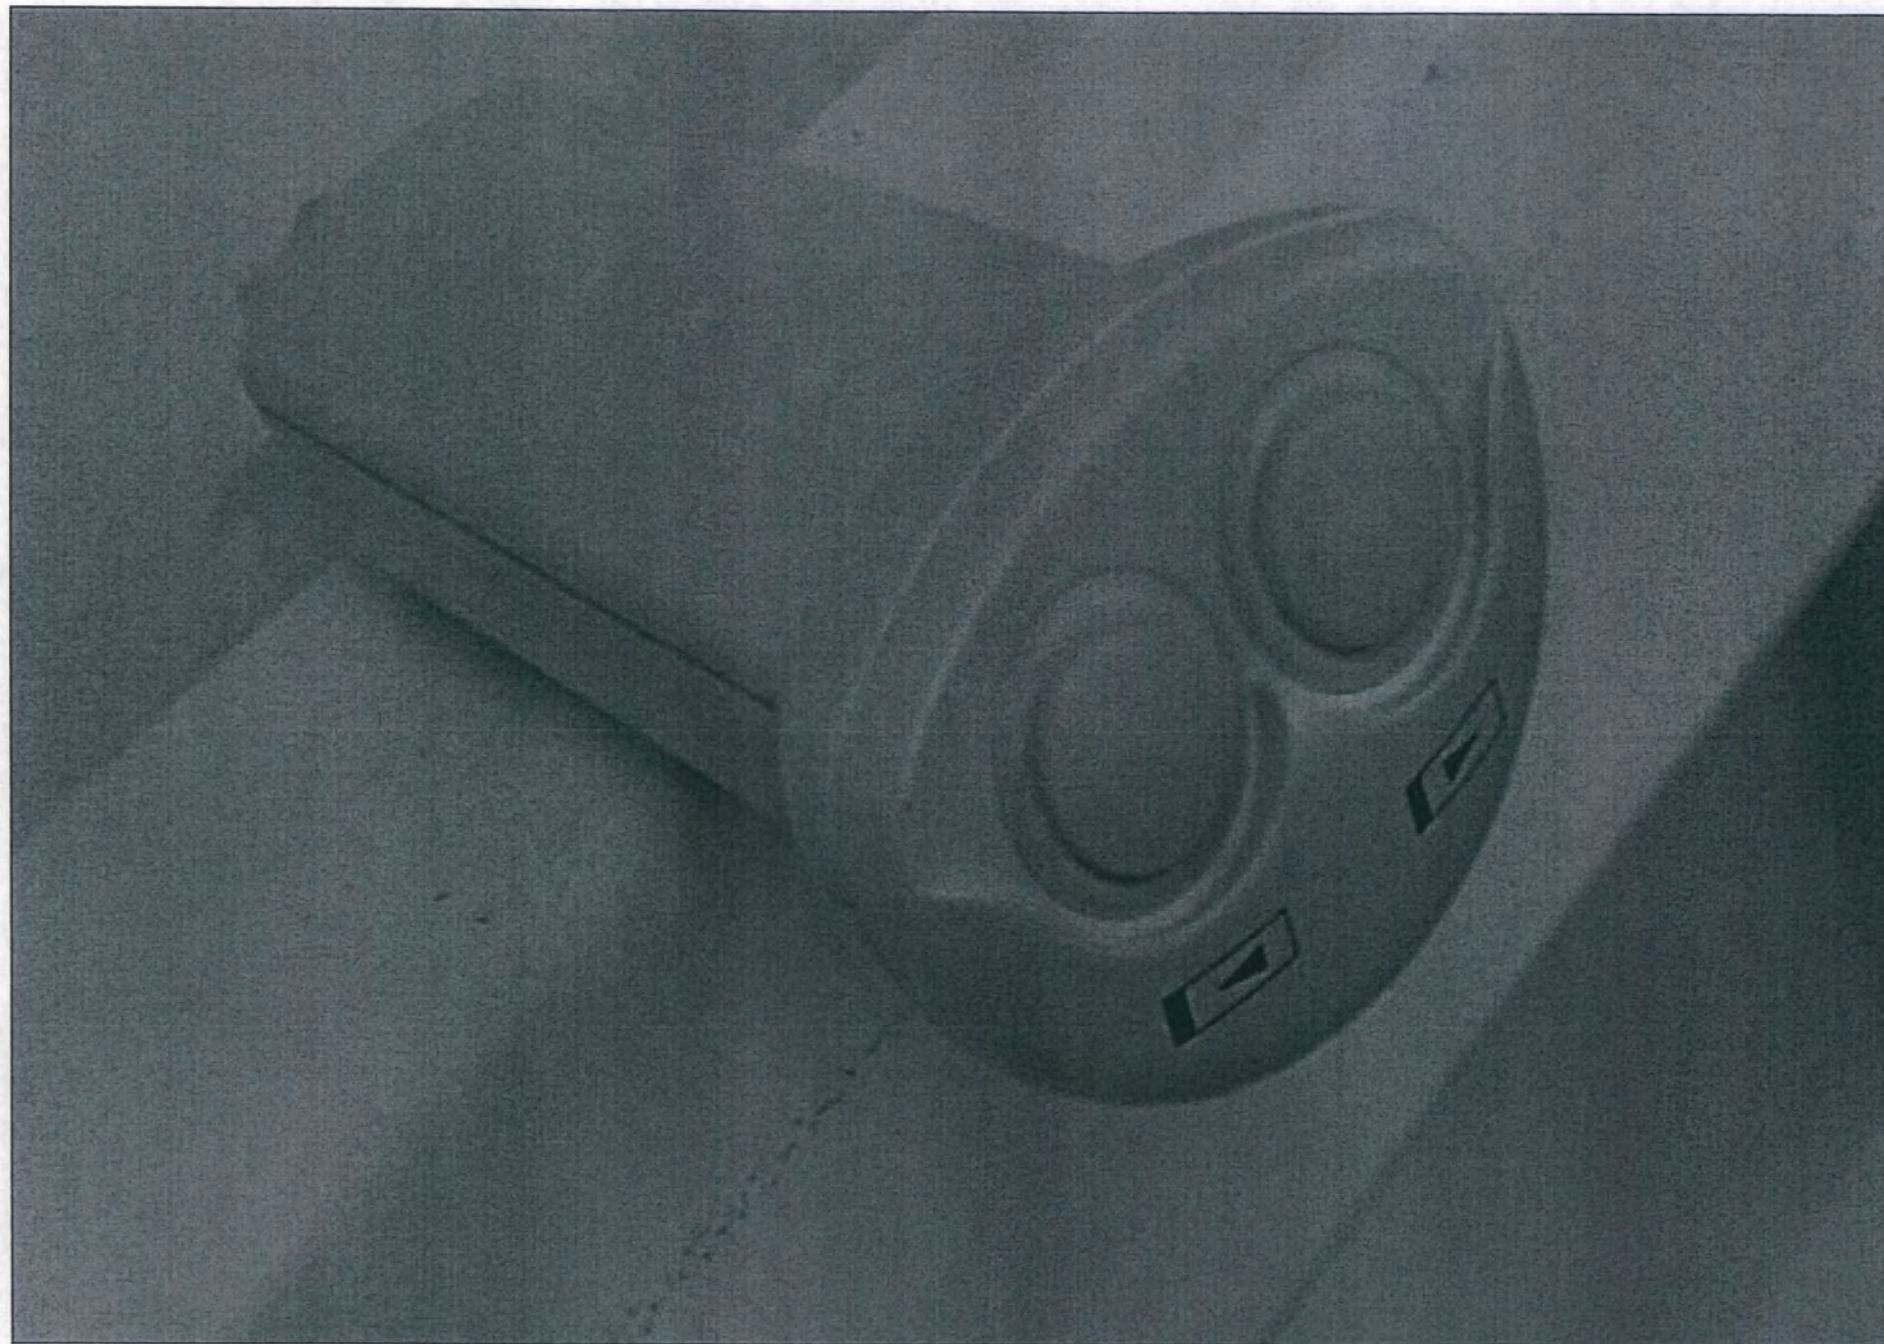


11. Ручной переключатель сдвига.

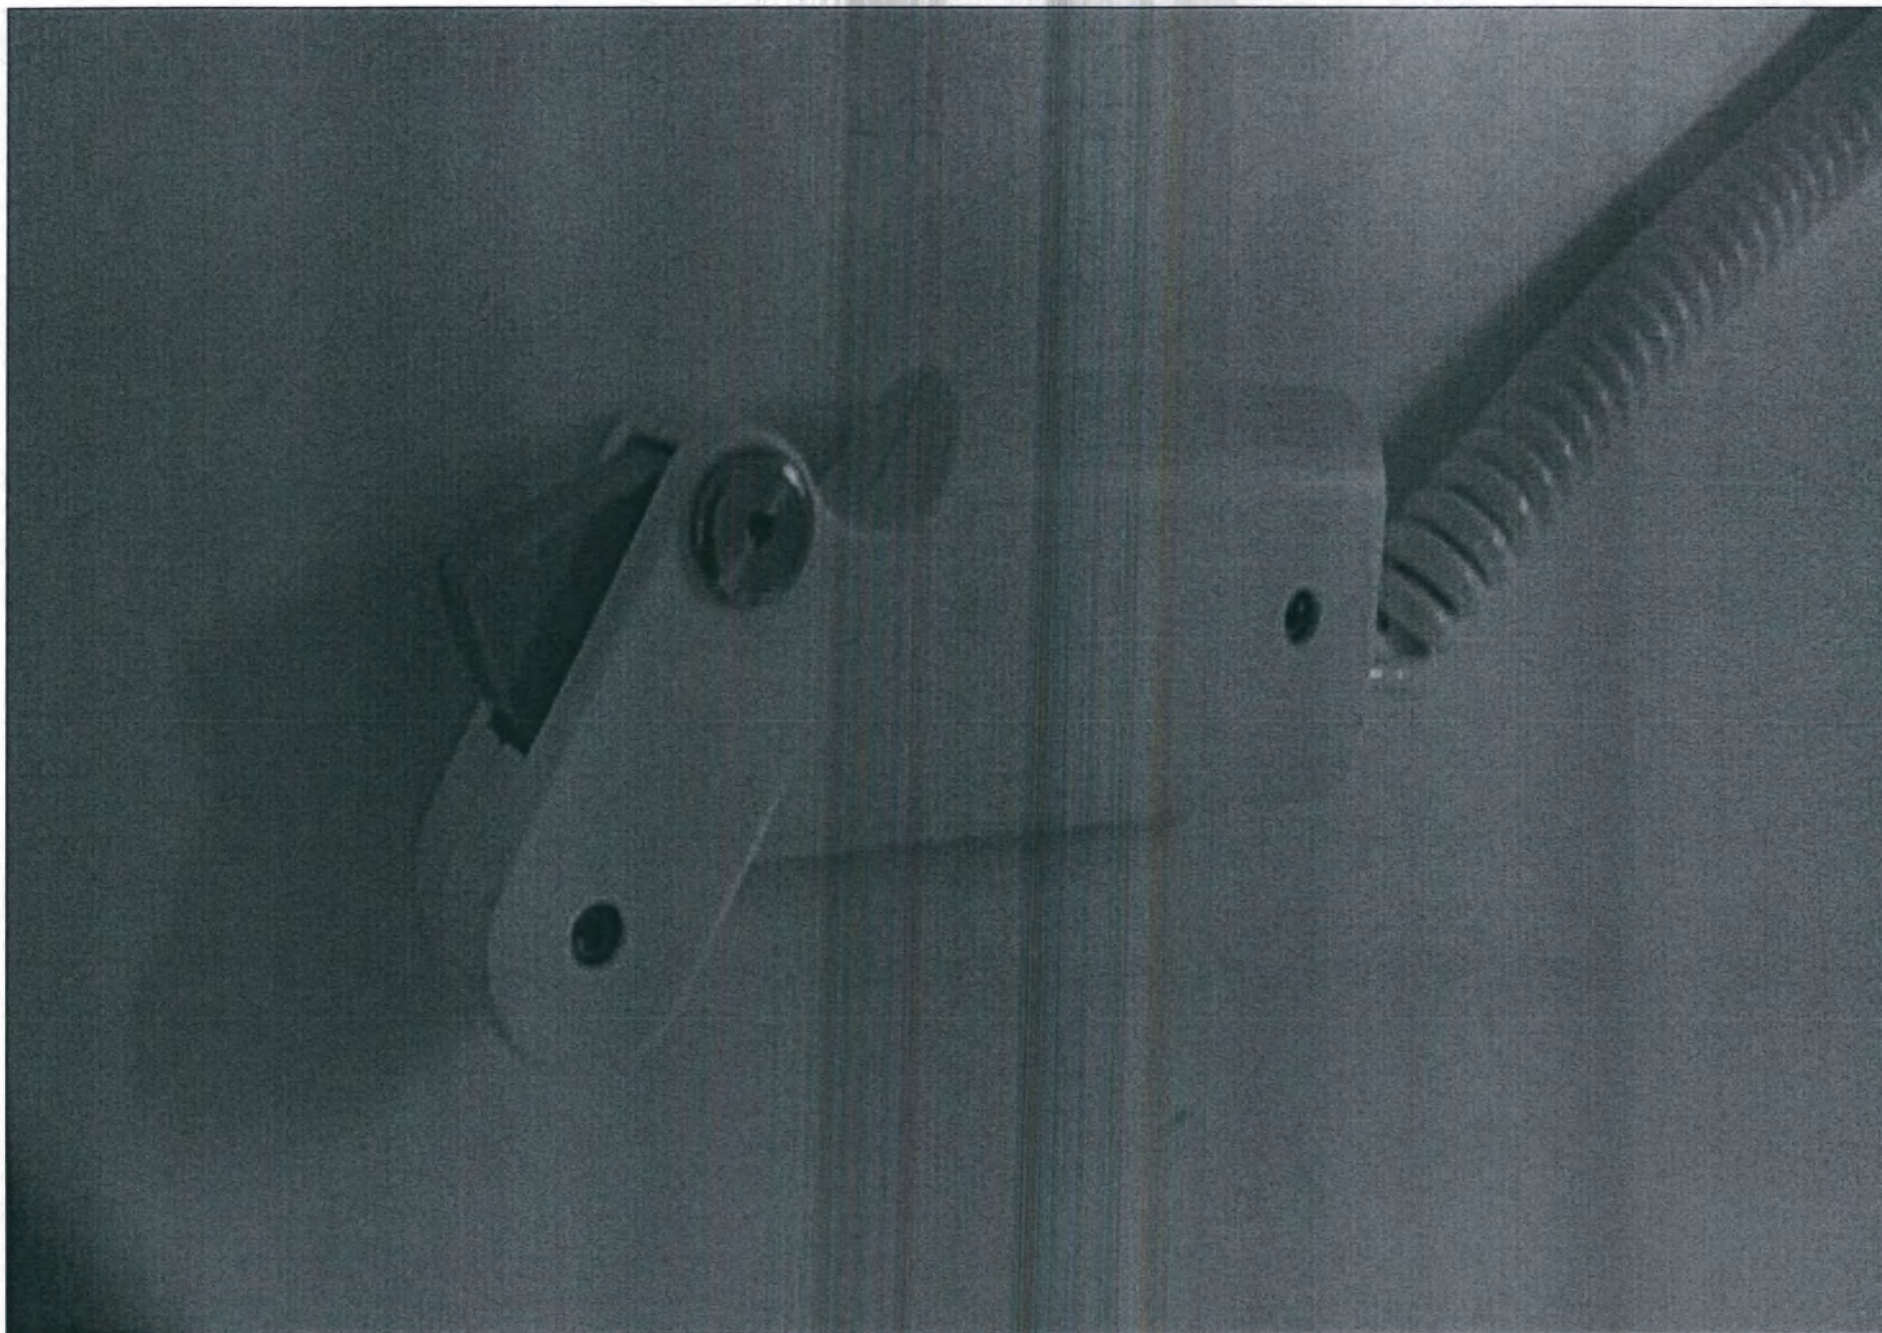


12. Регулятор скорости.

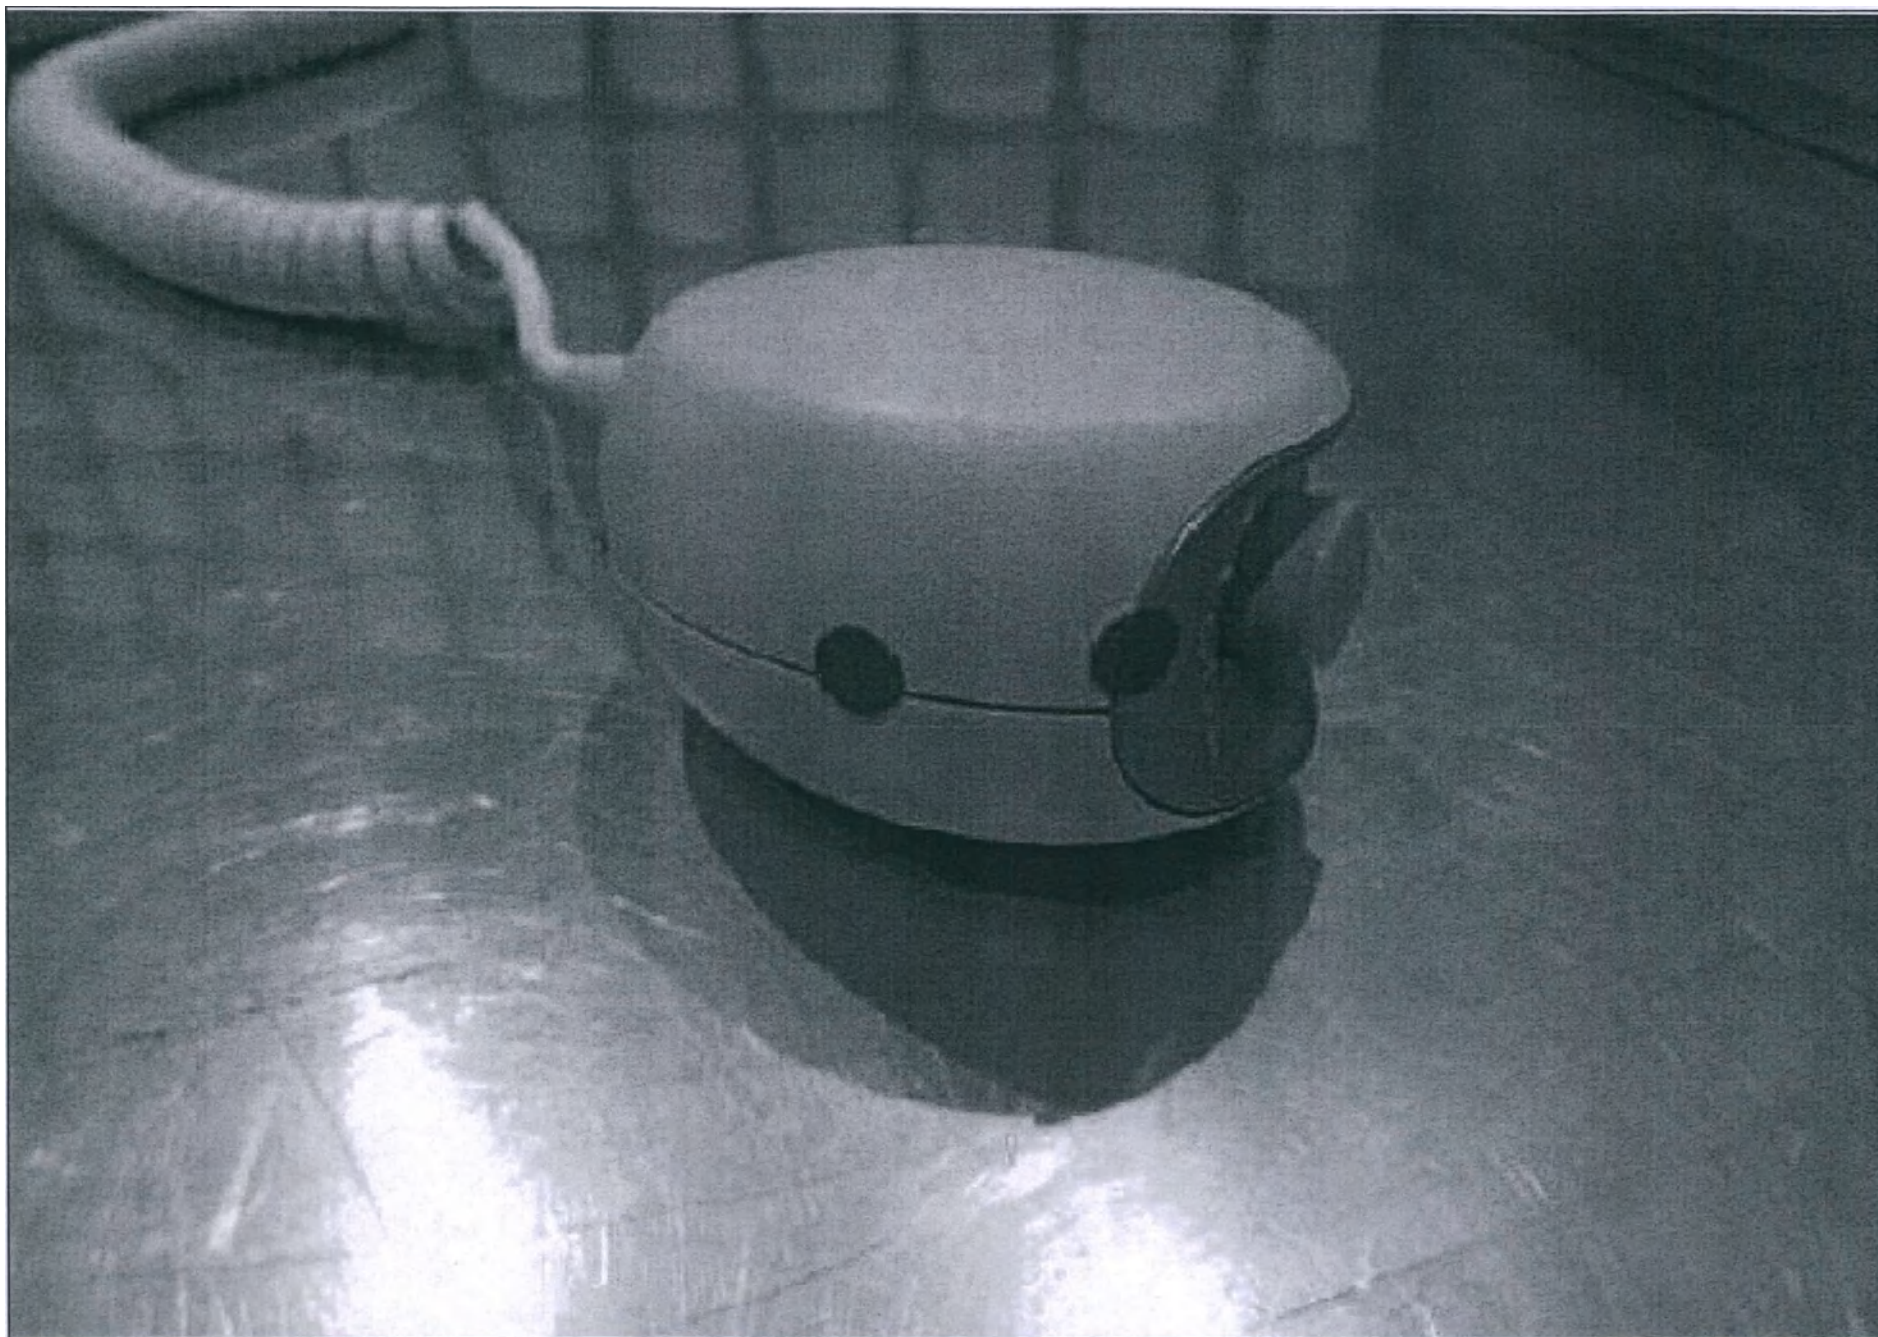


13. Ручной переключатель экспозиции.

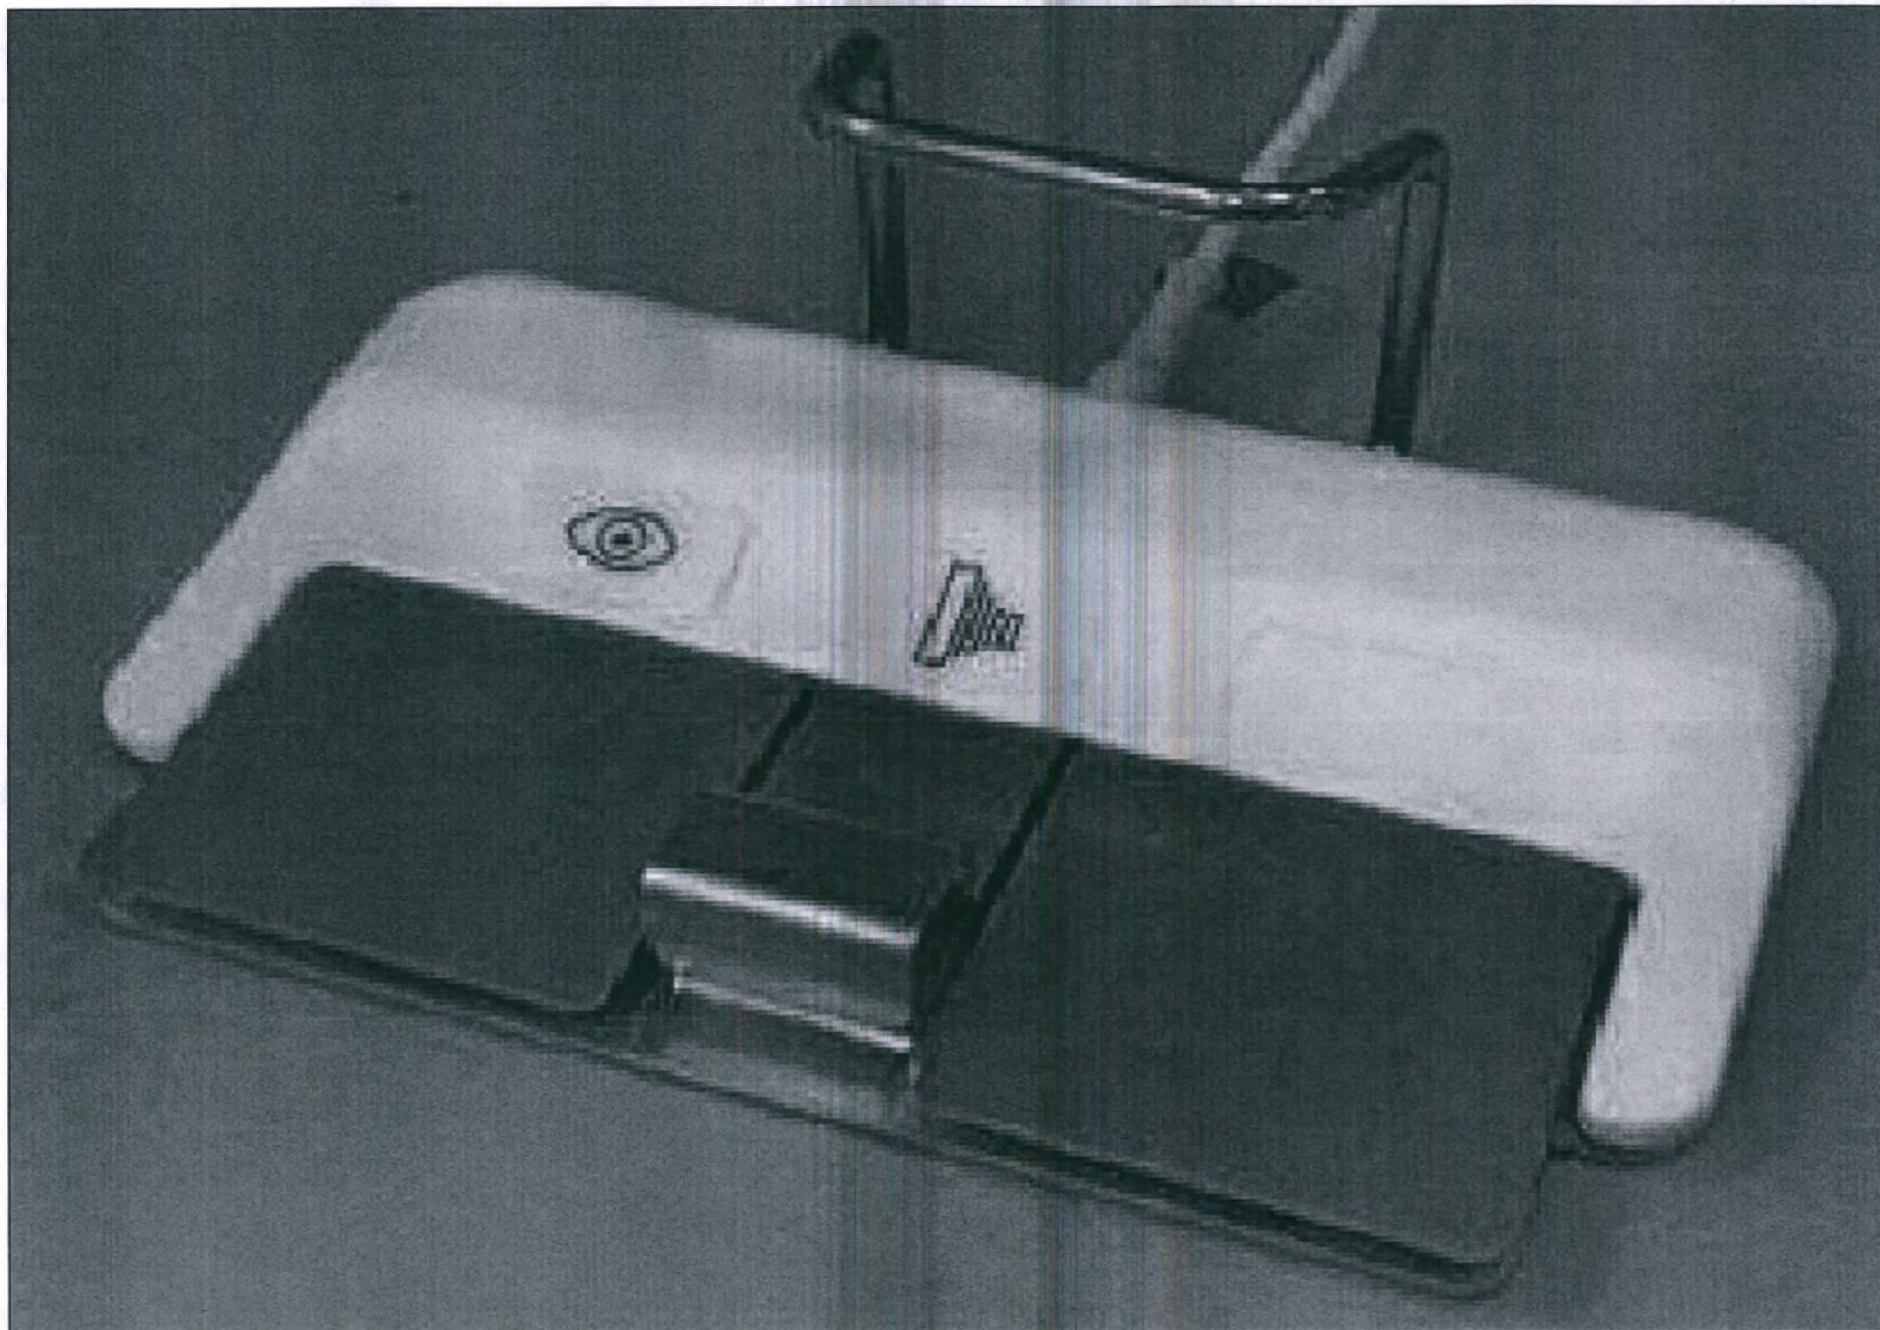


14. Ножной переключатель, не более 2 шт.

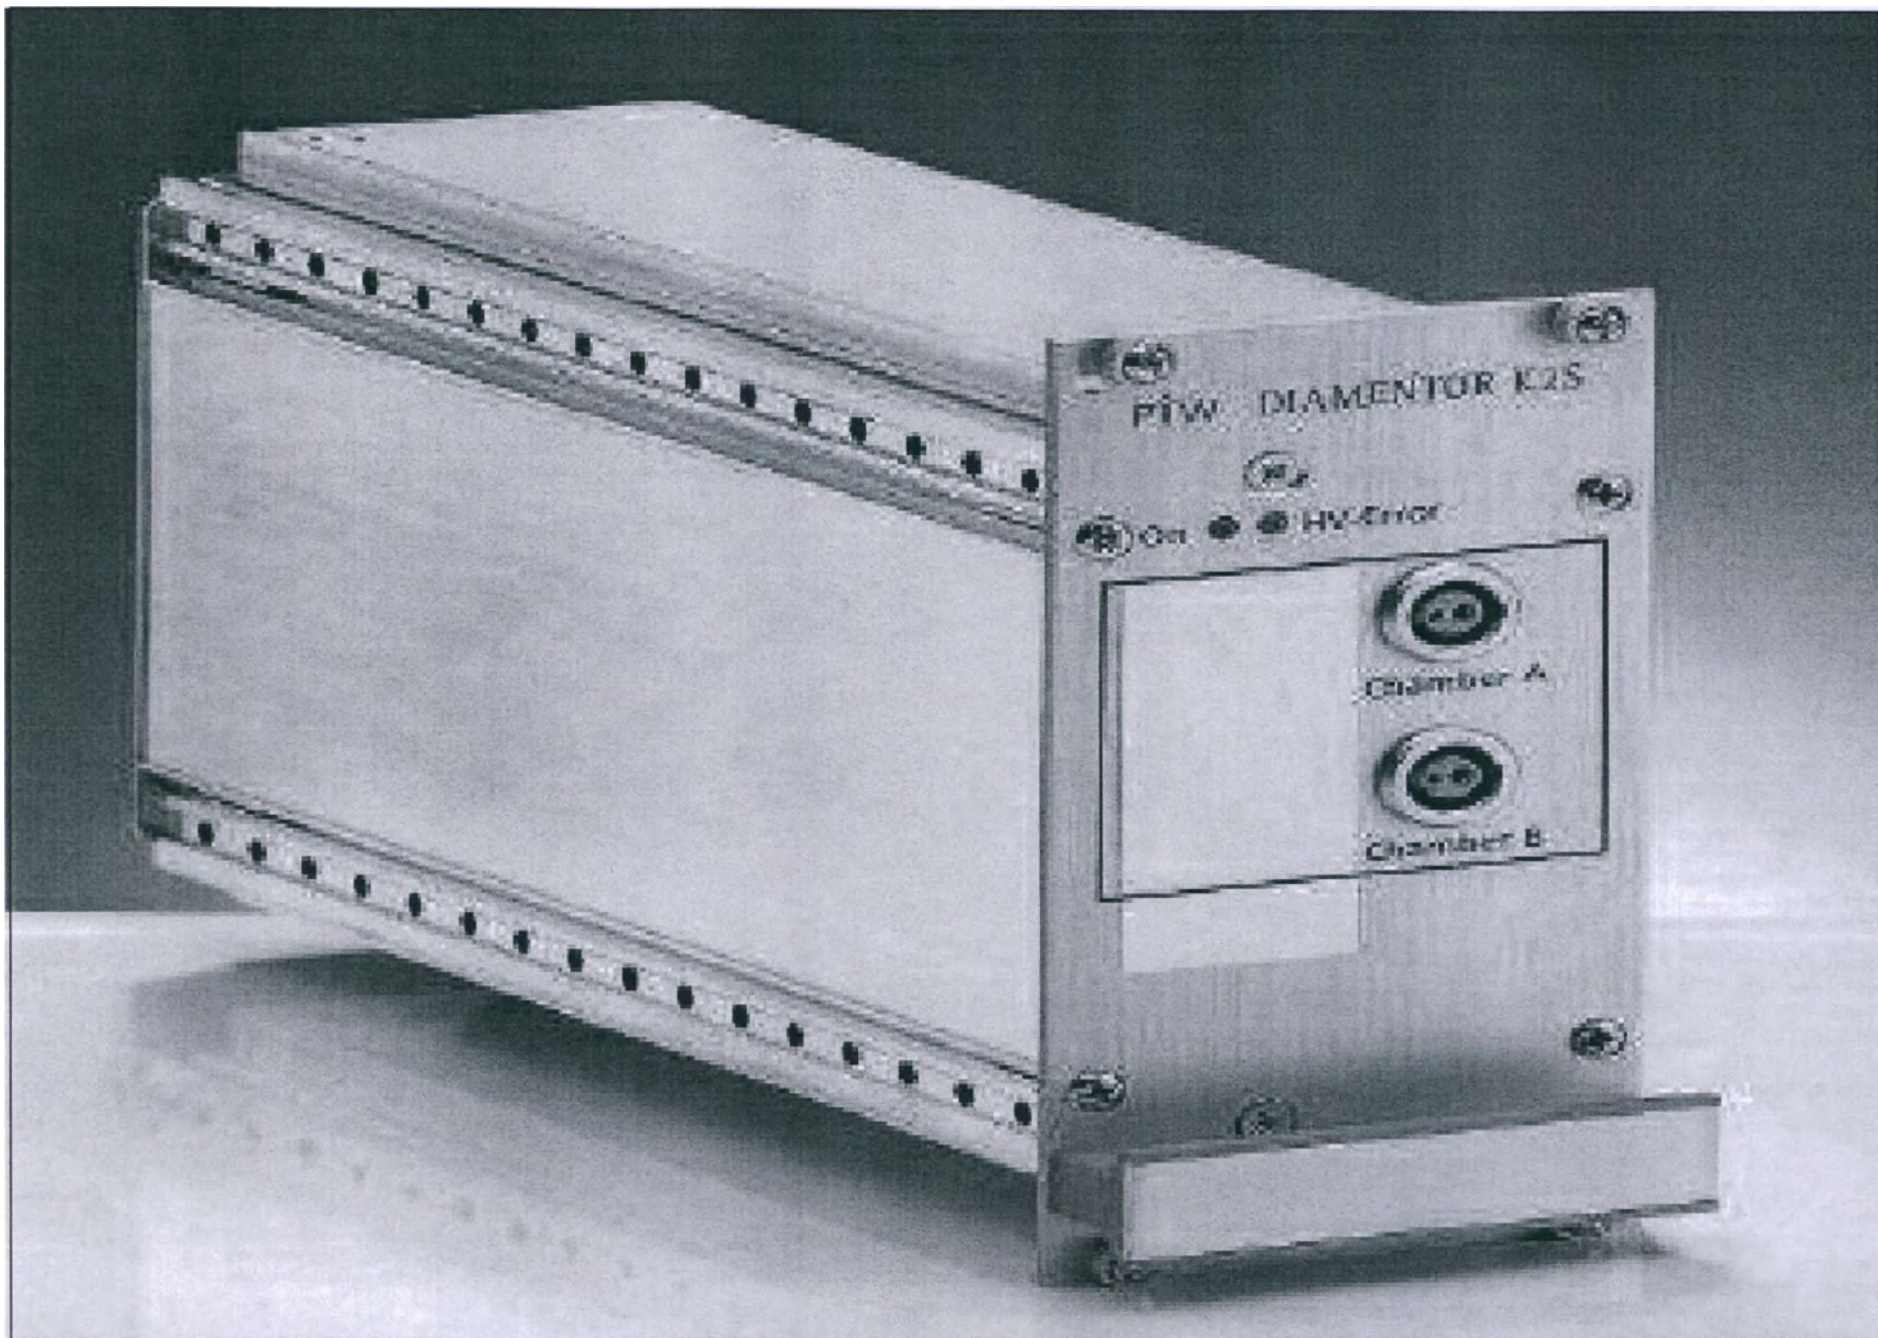


15.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

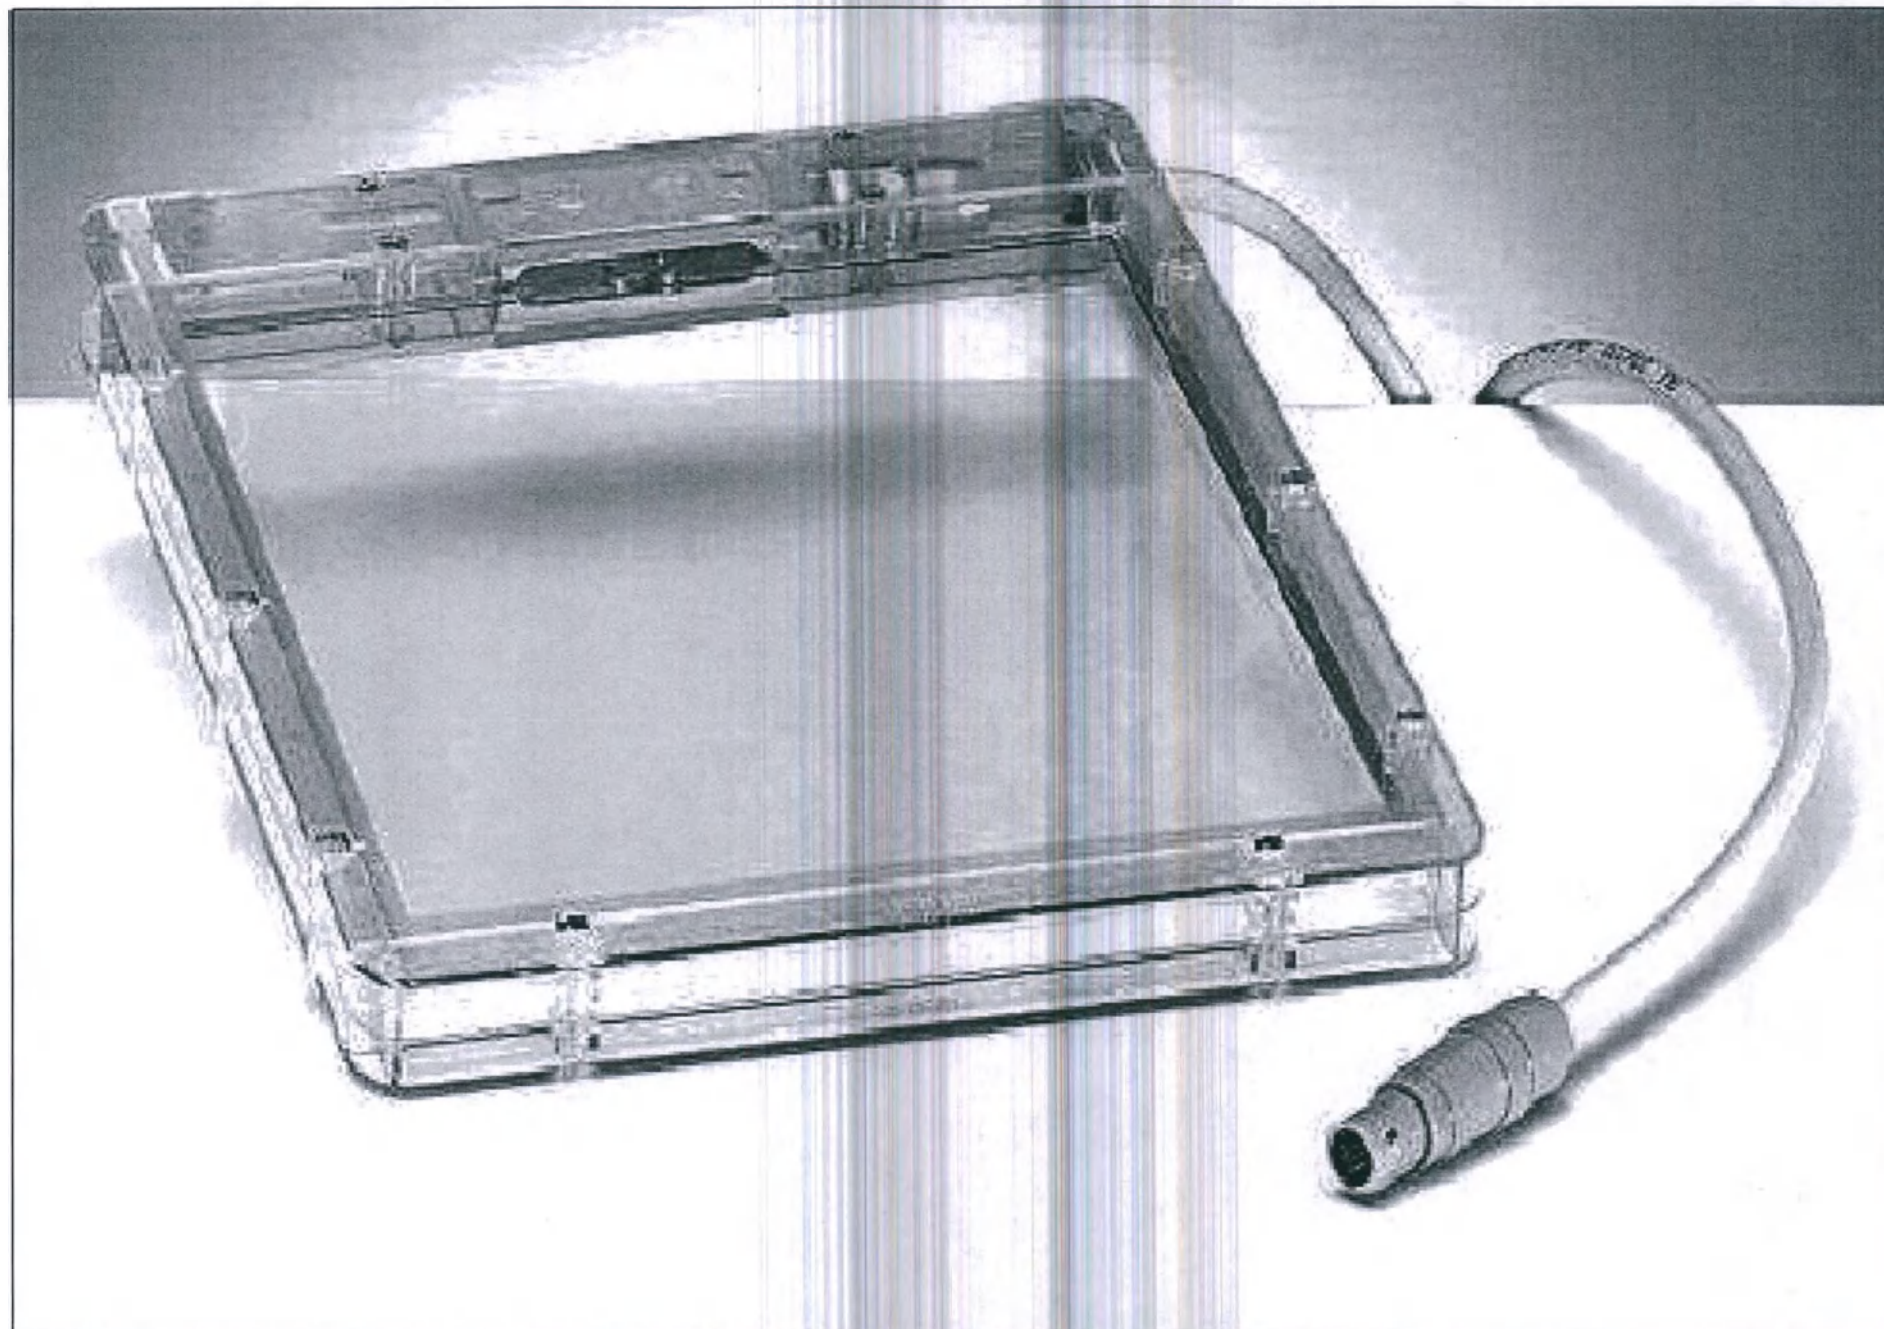


15.б. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДРК-1* или *ДРК-1М*.

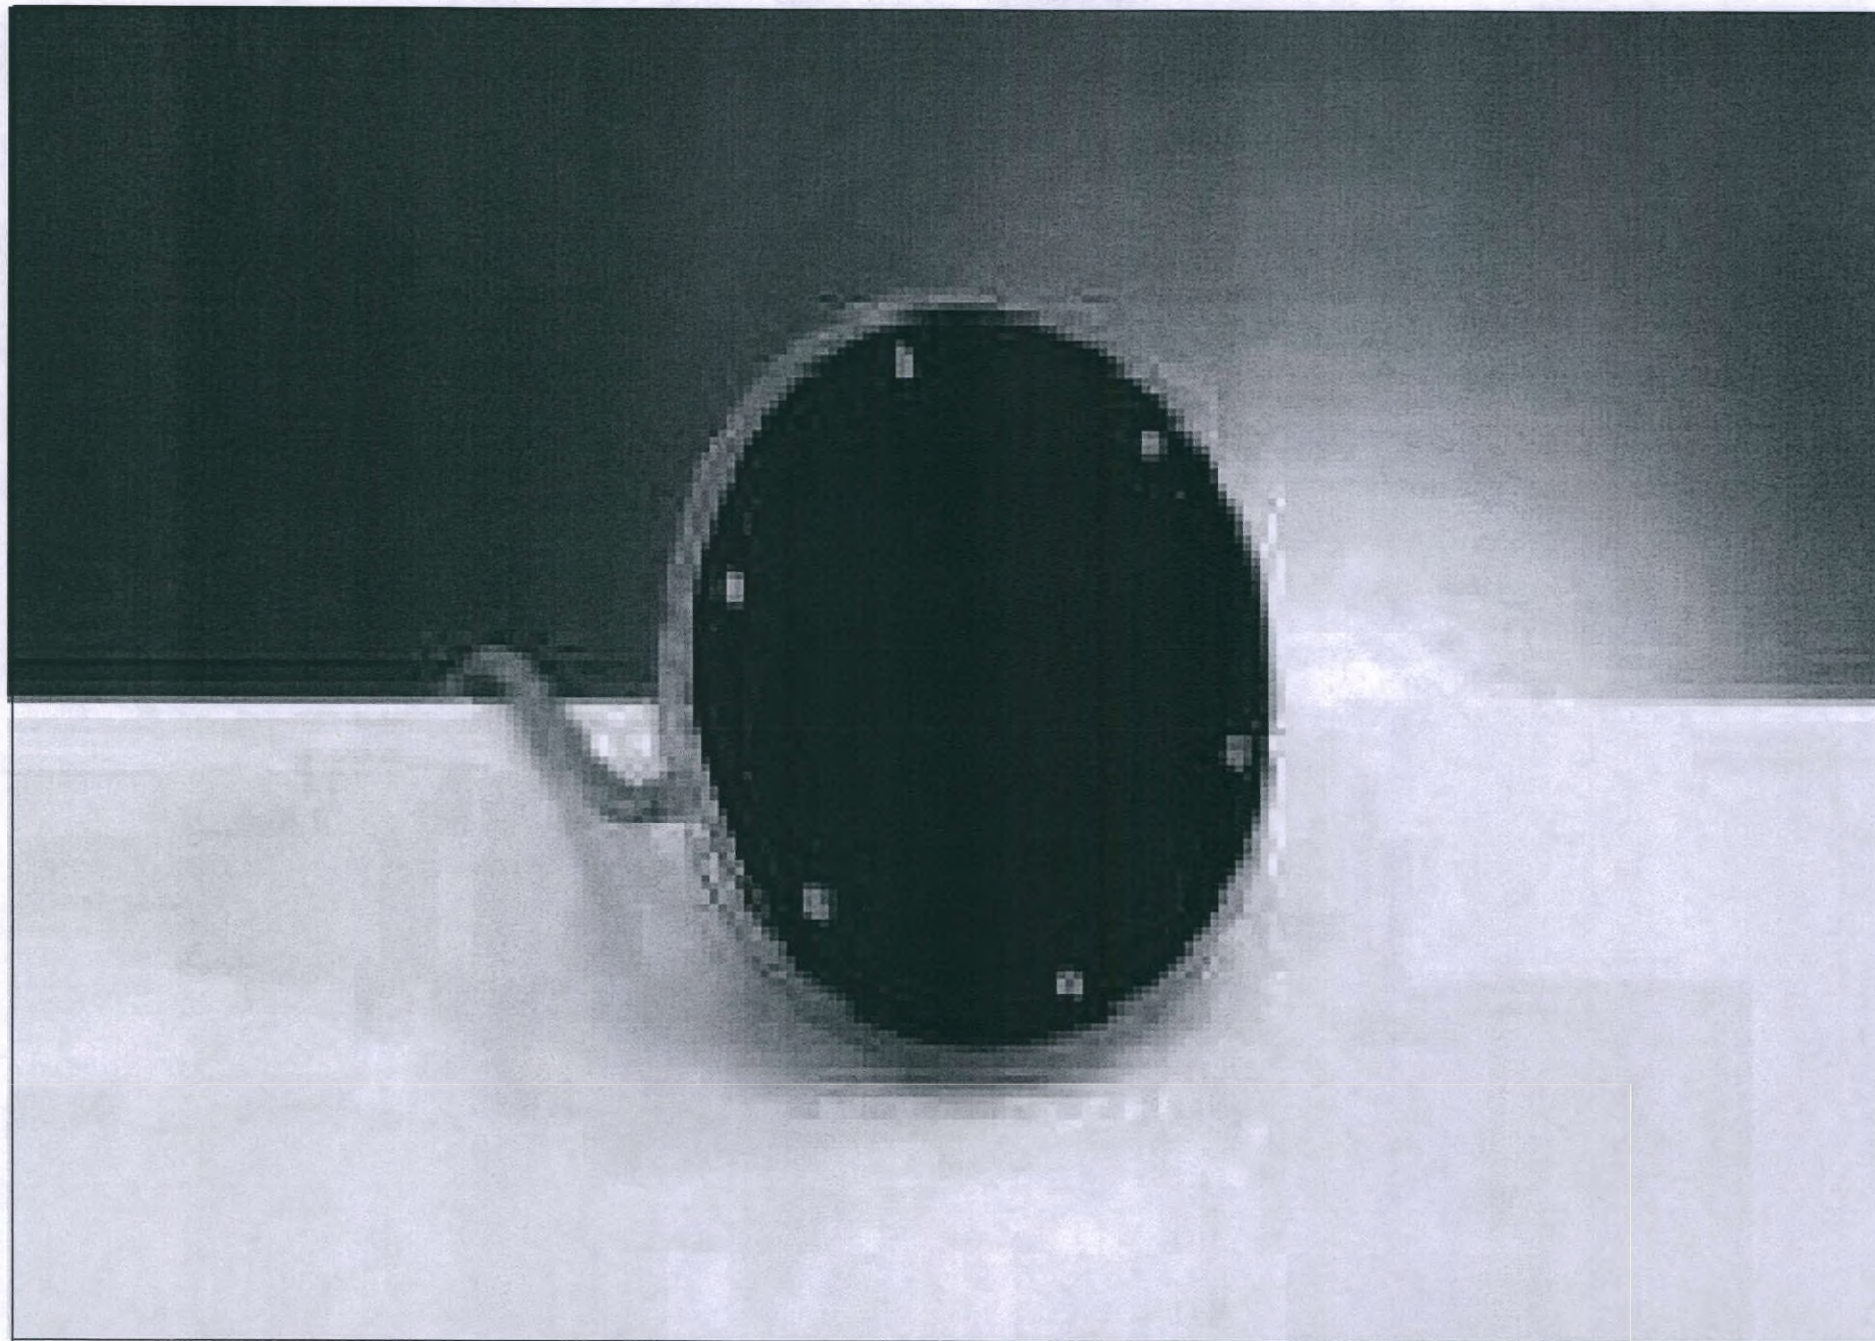


15.в. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

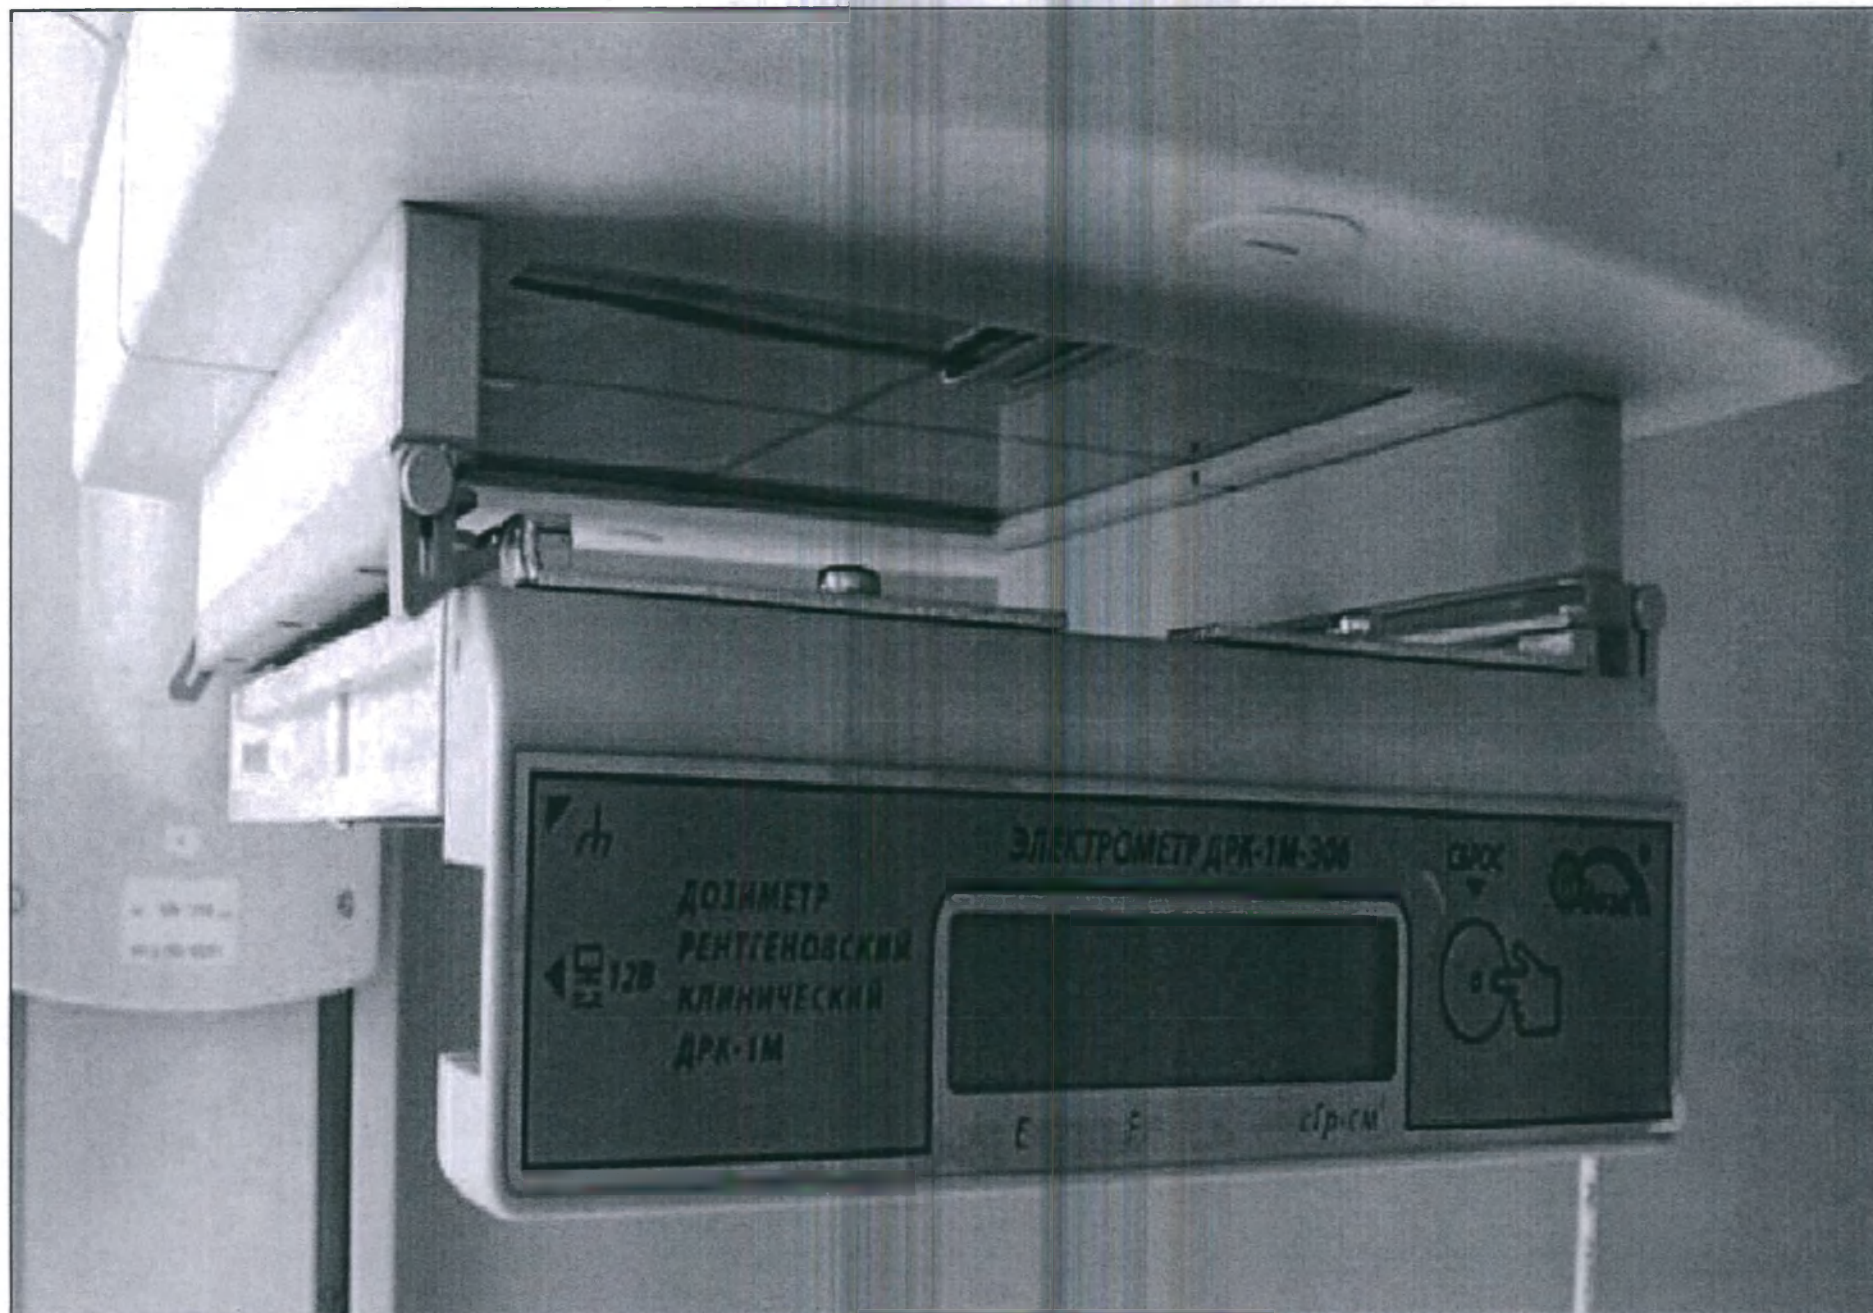


15.г. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

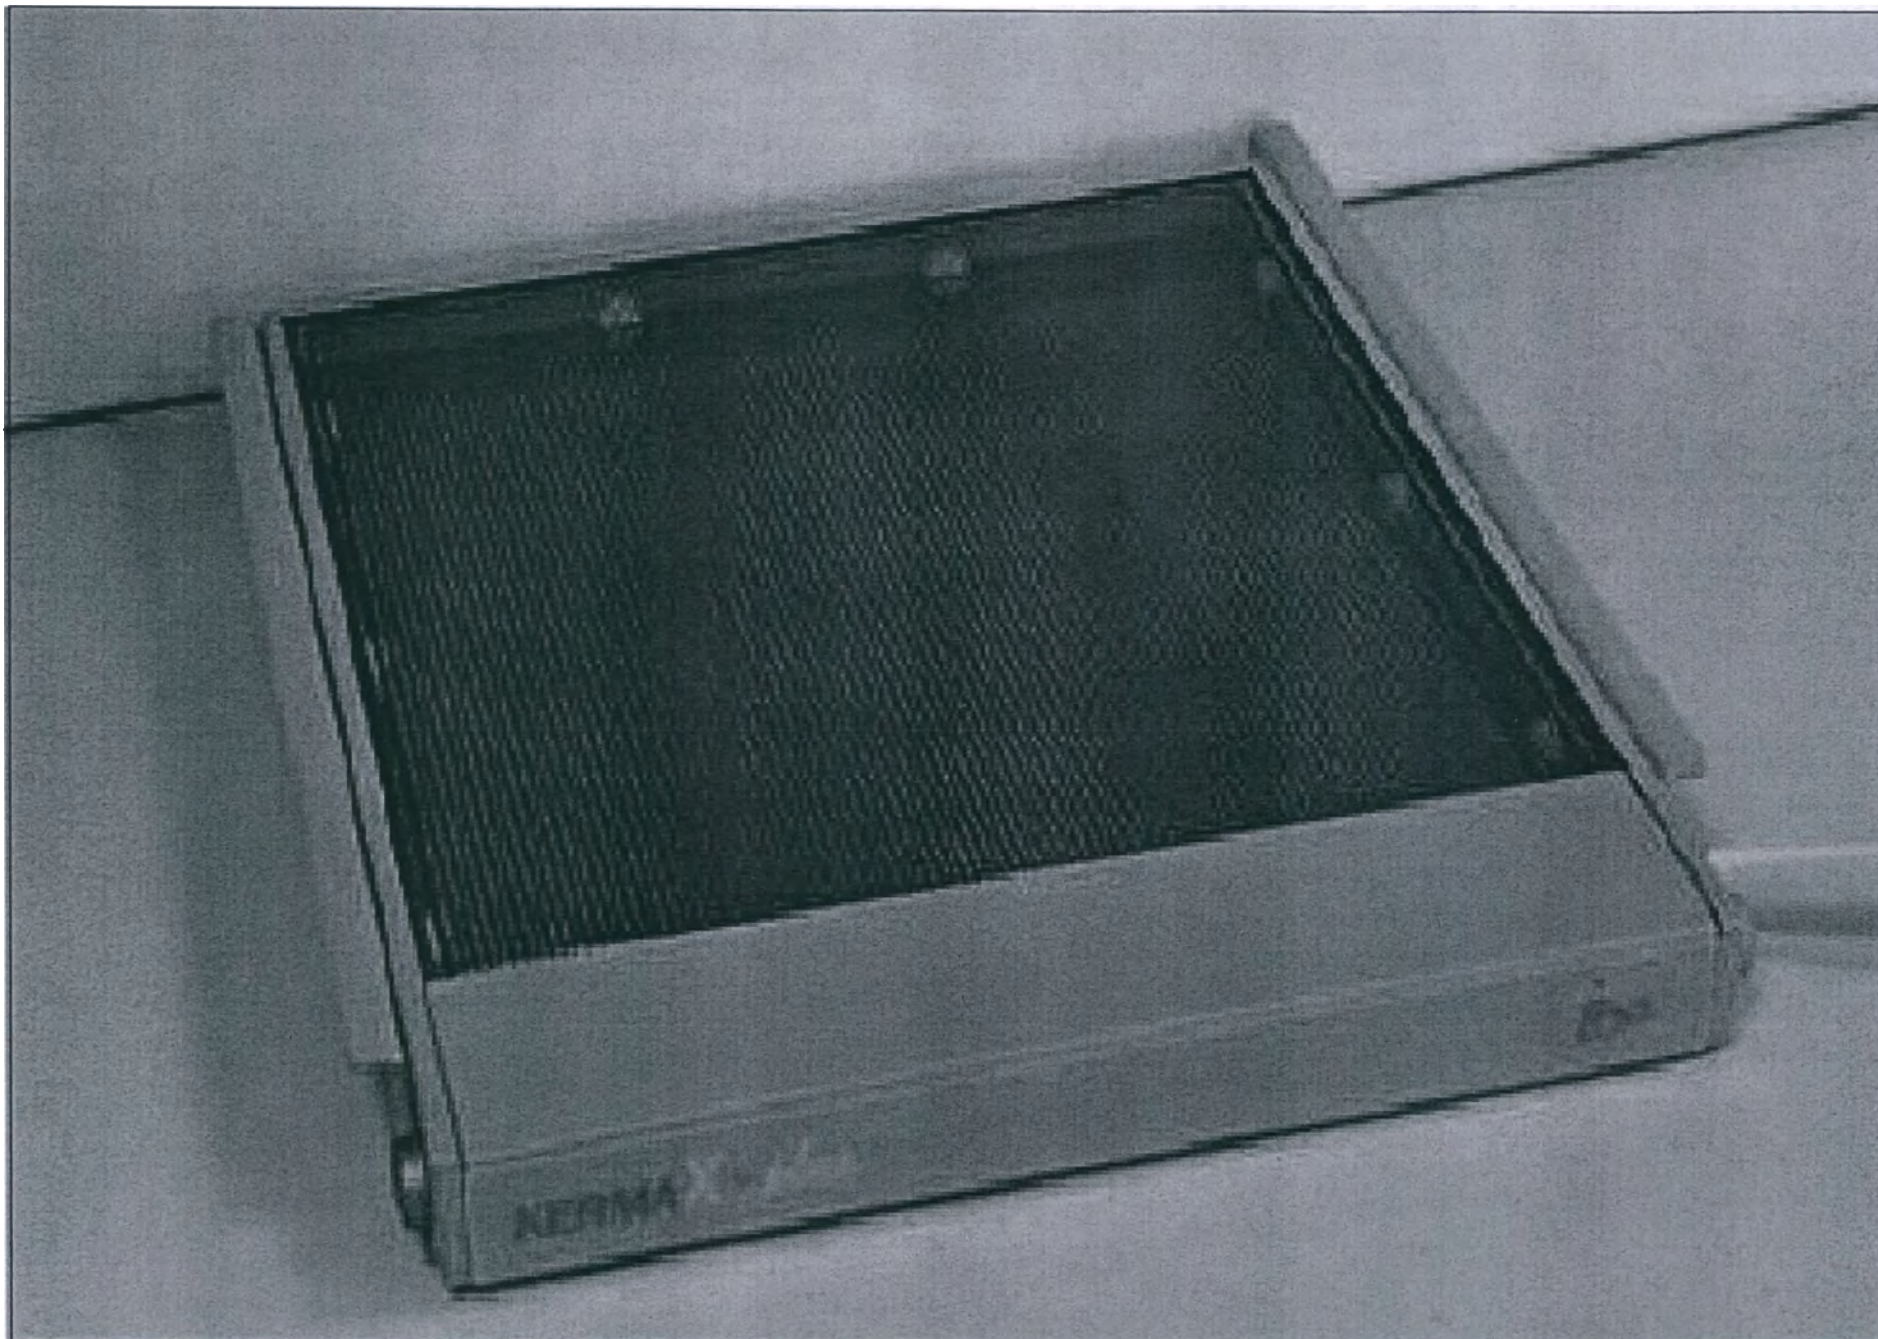


16. Измеритель произведения дозы на площадь KermaX plus 120-132.

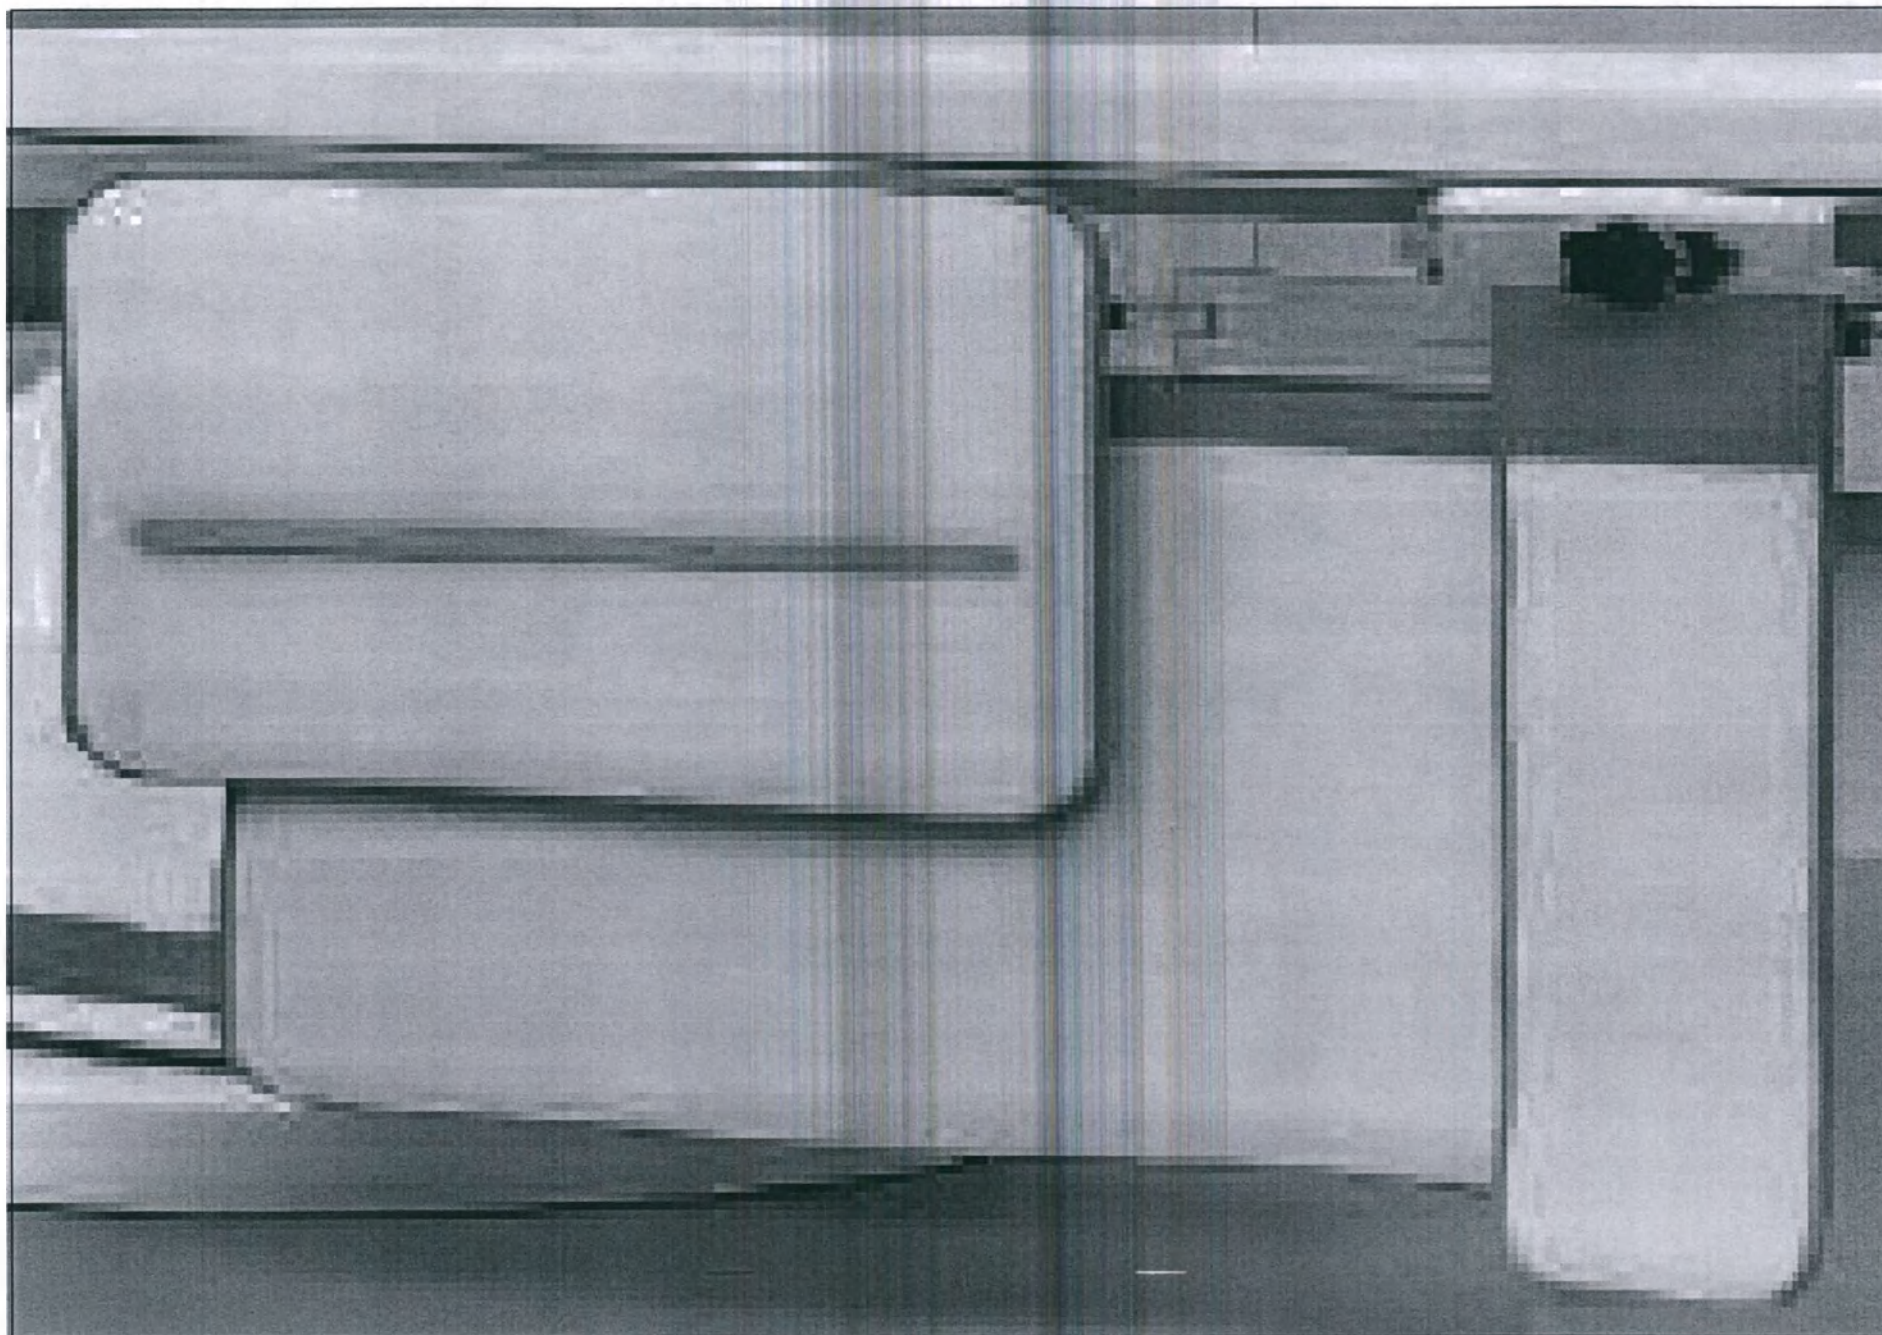


17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

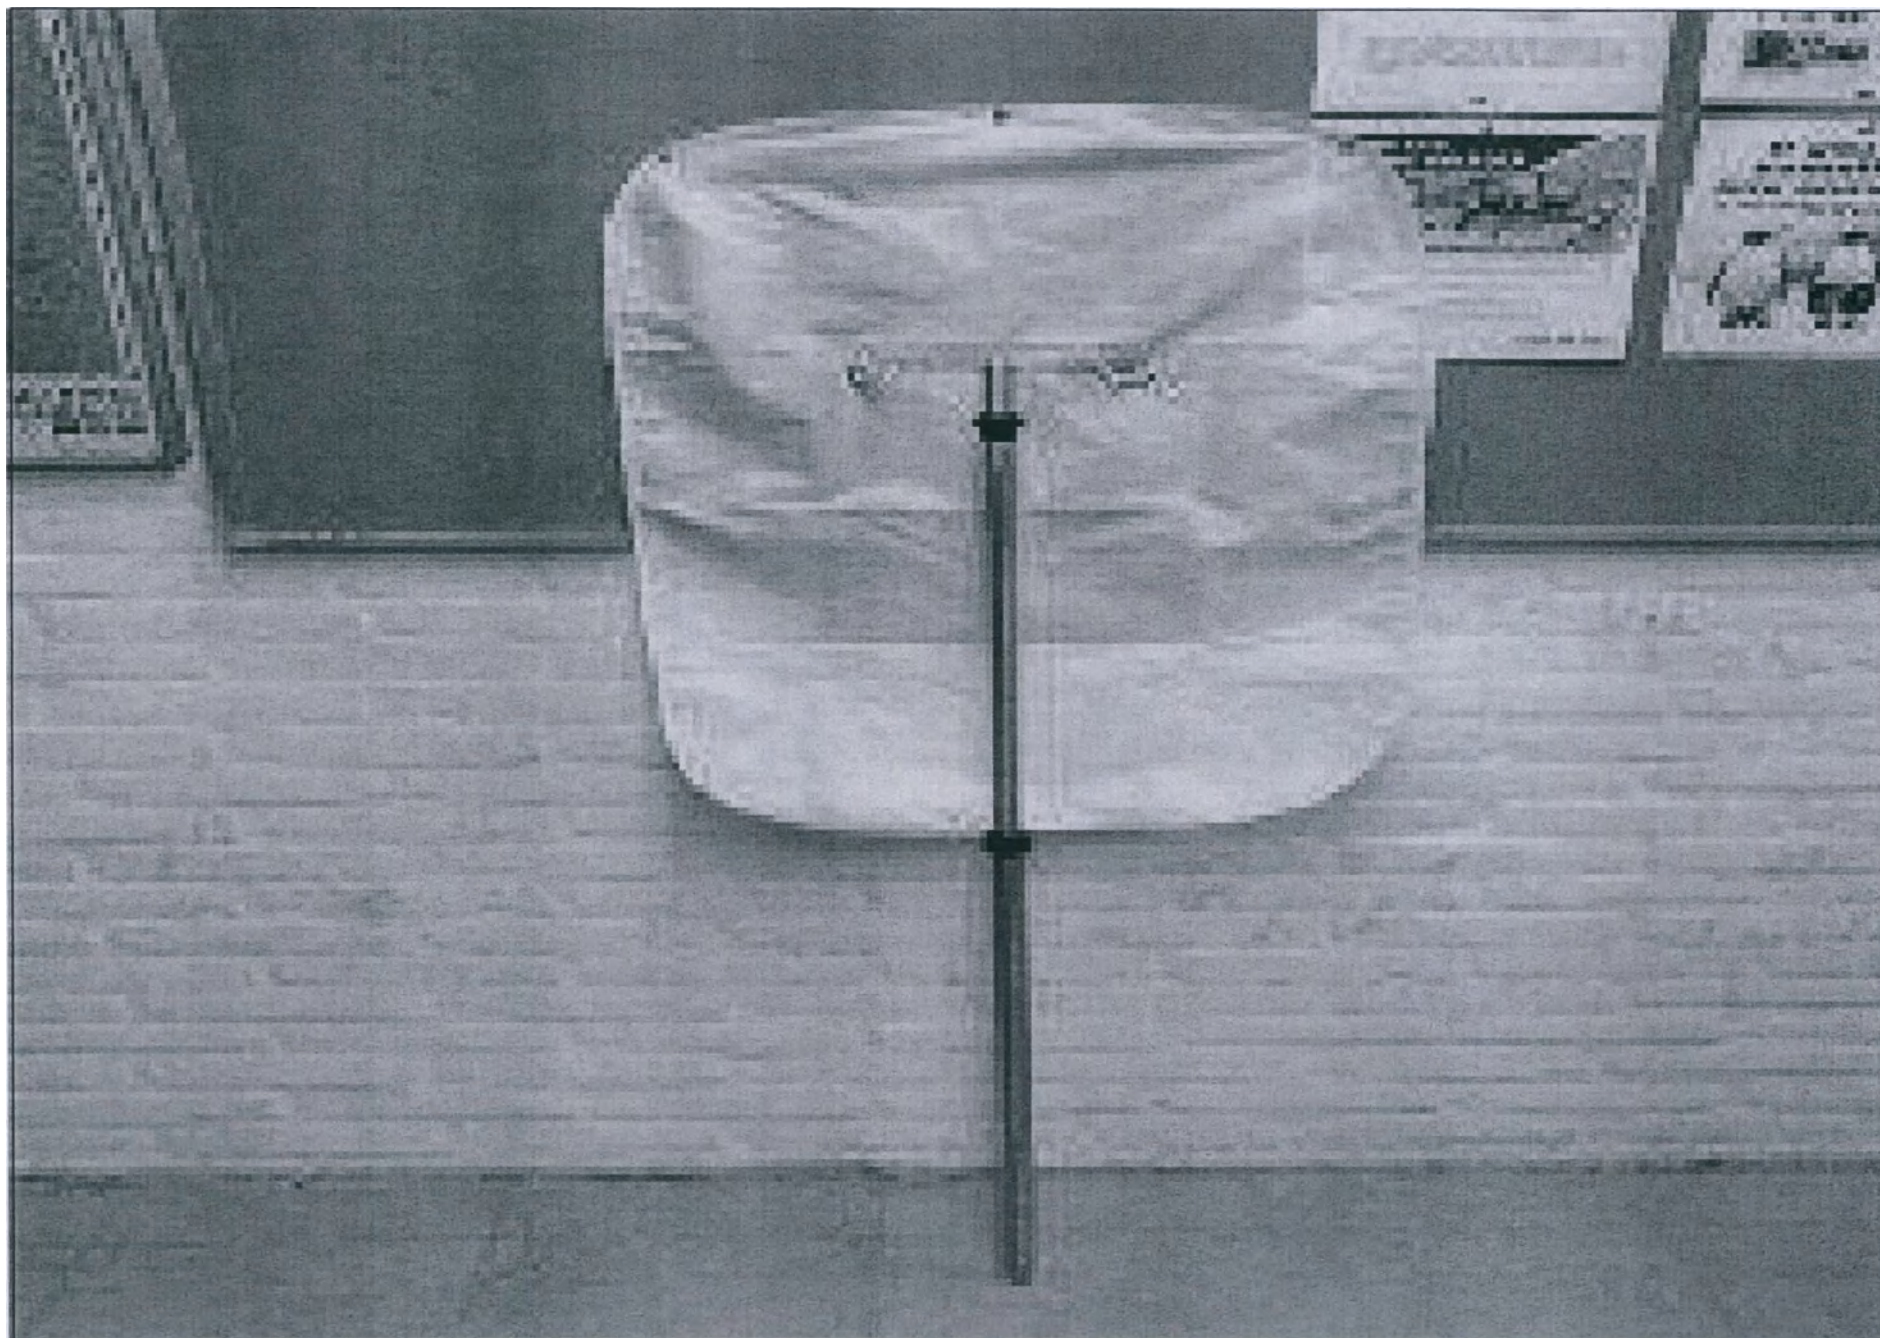


18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

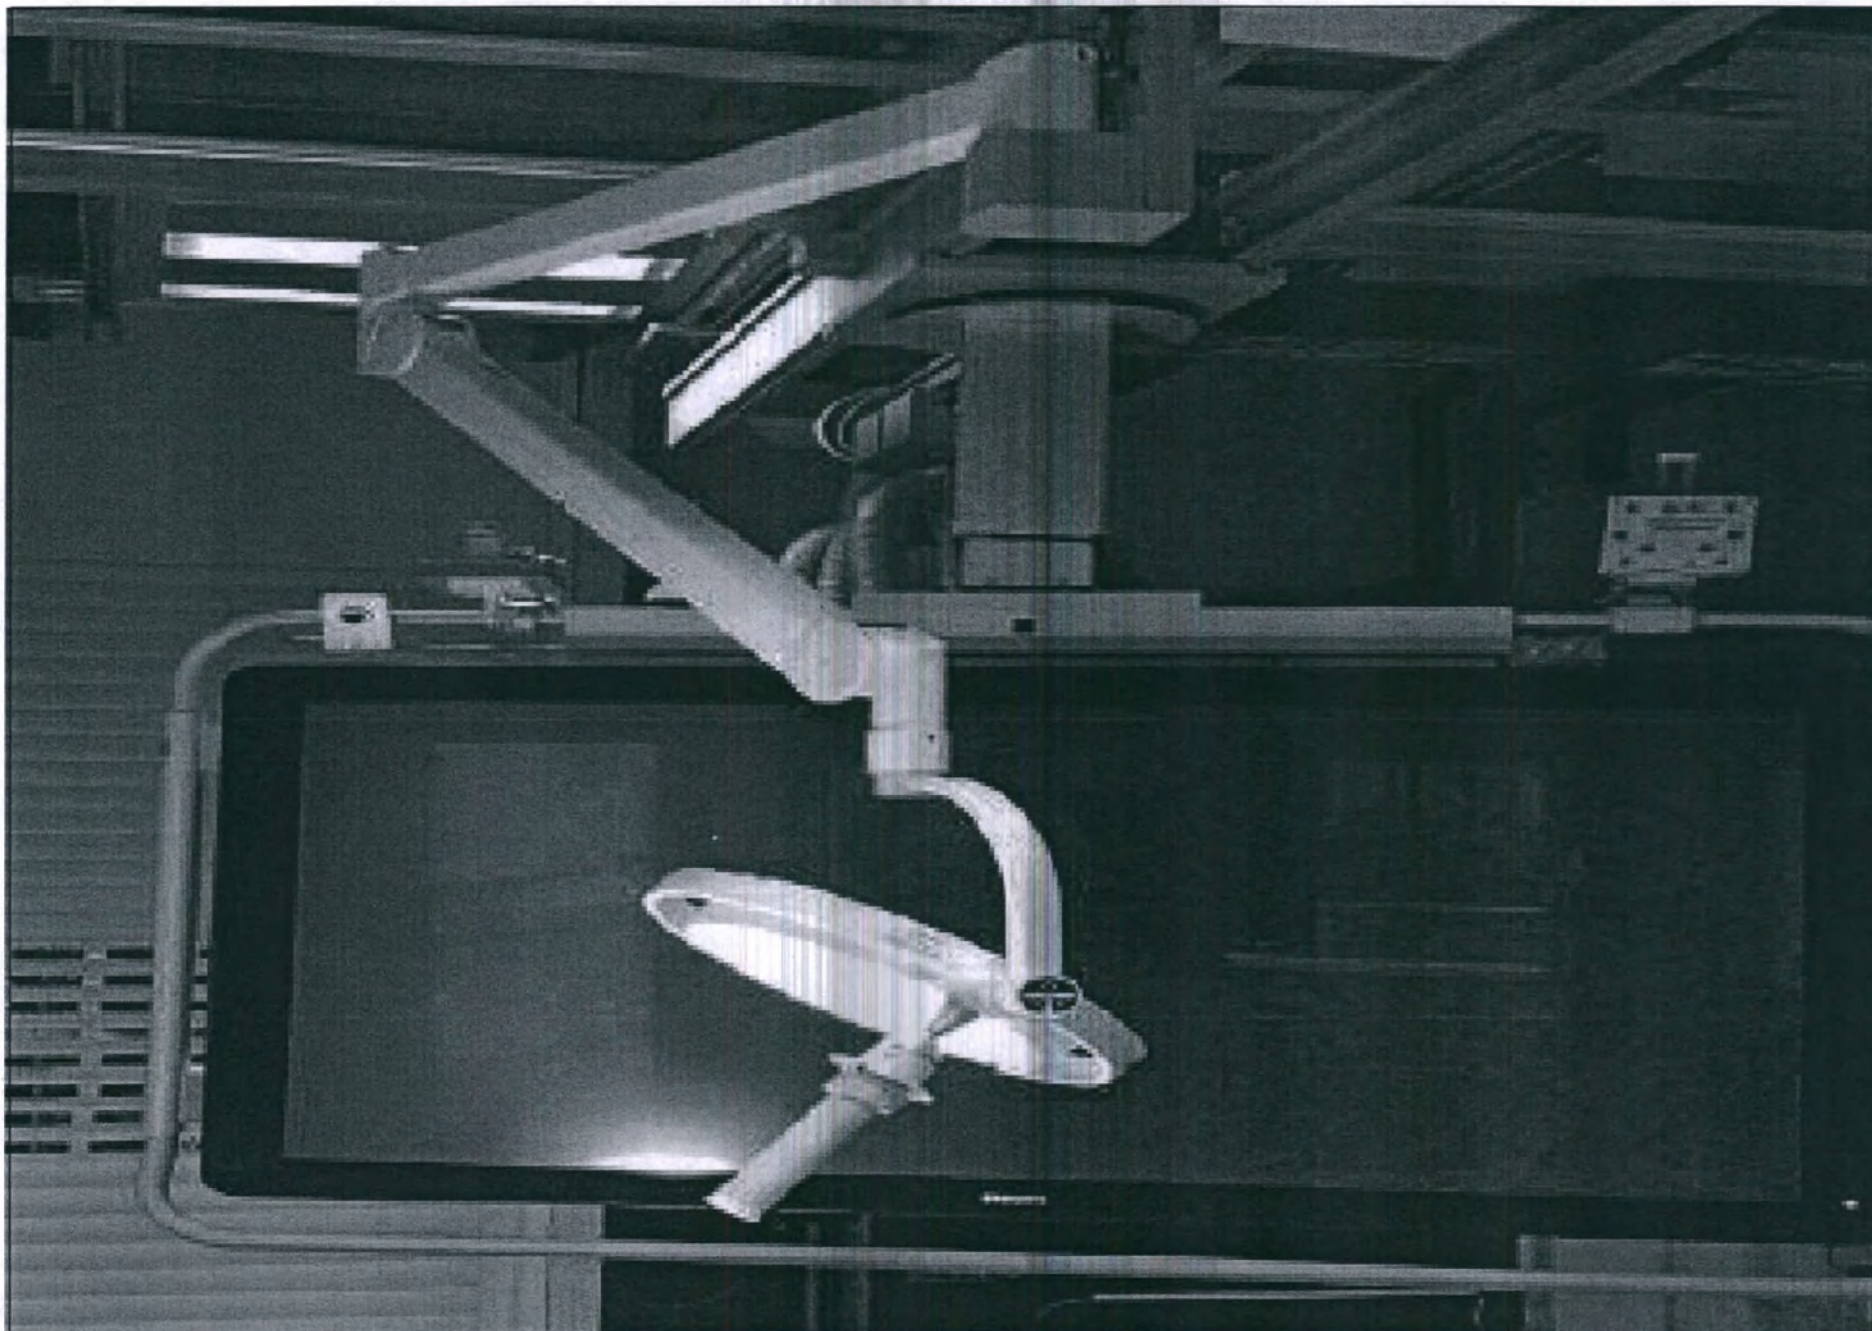

19. Лампа для осмотра.

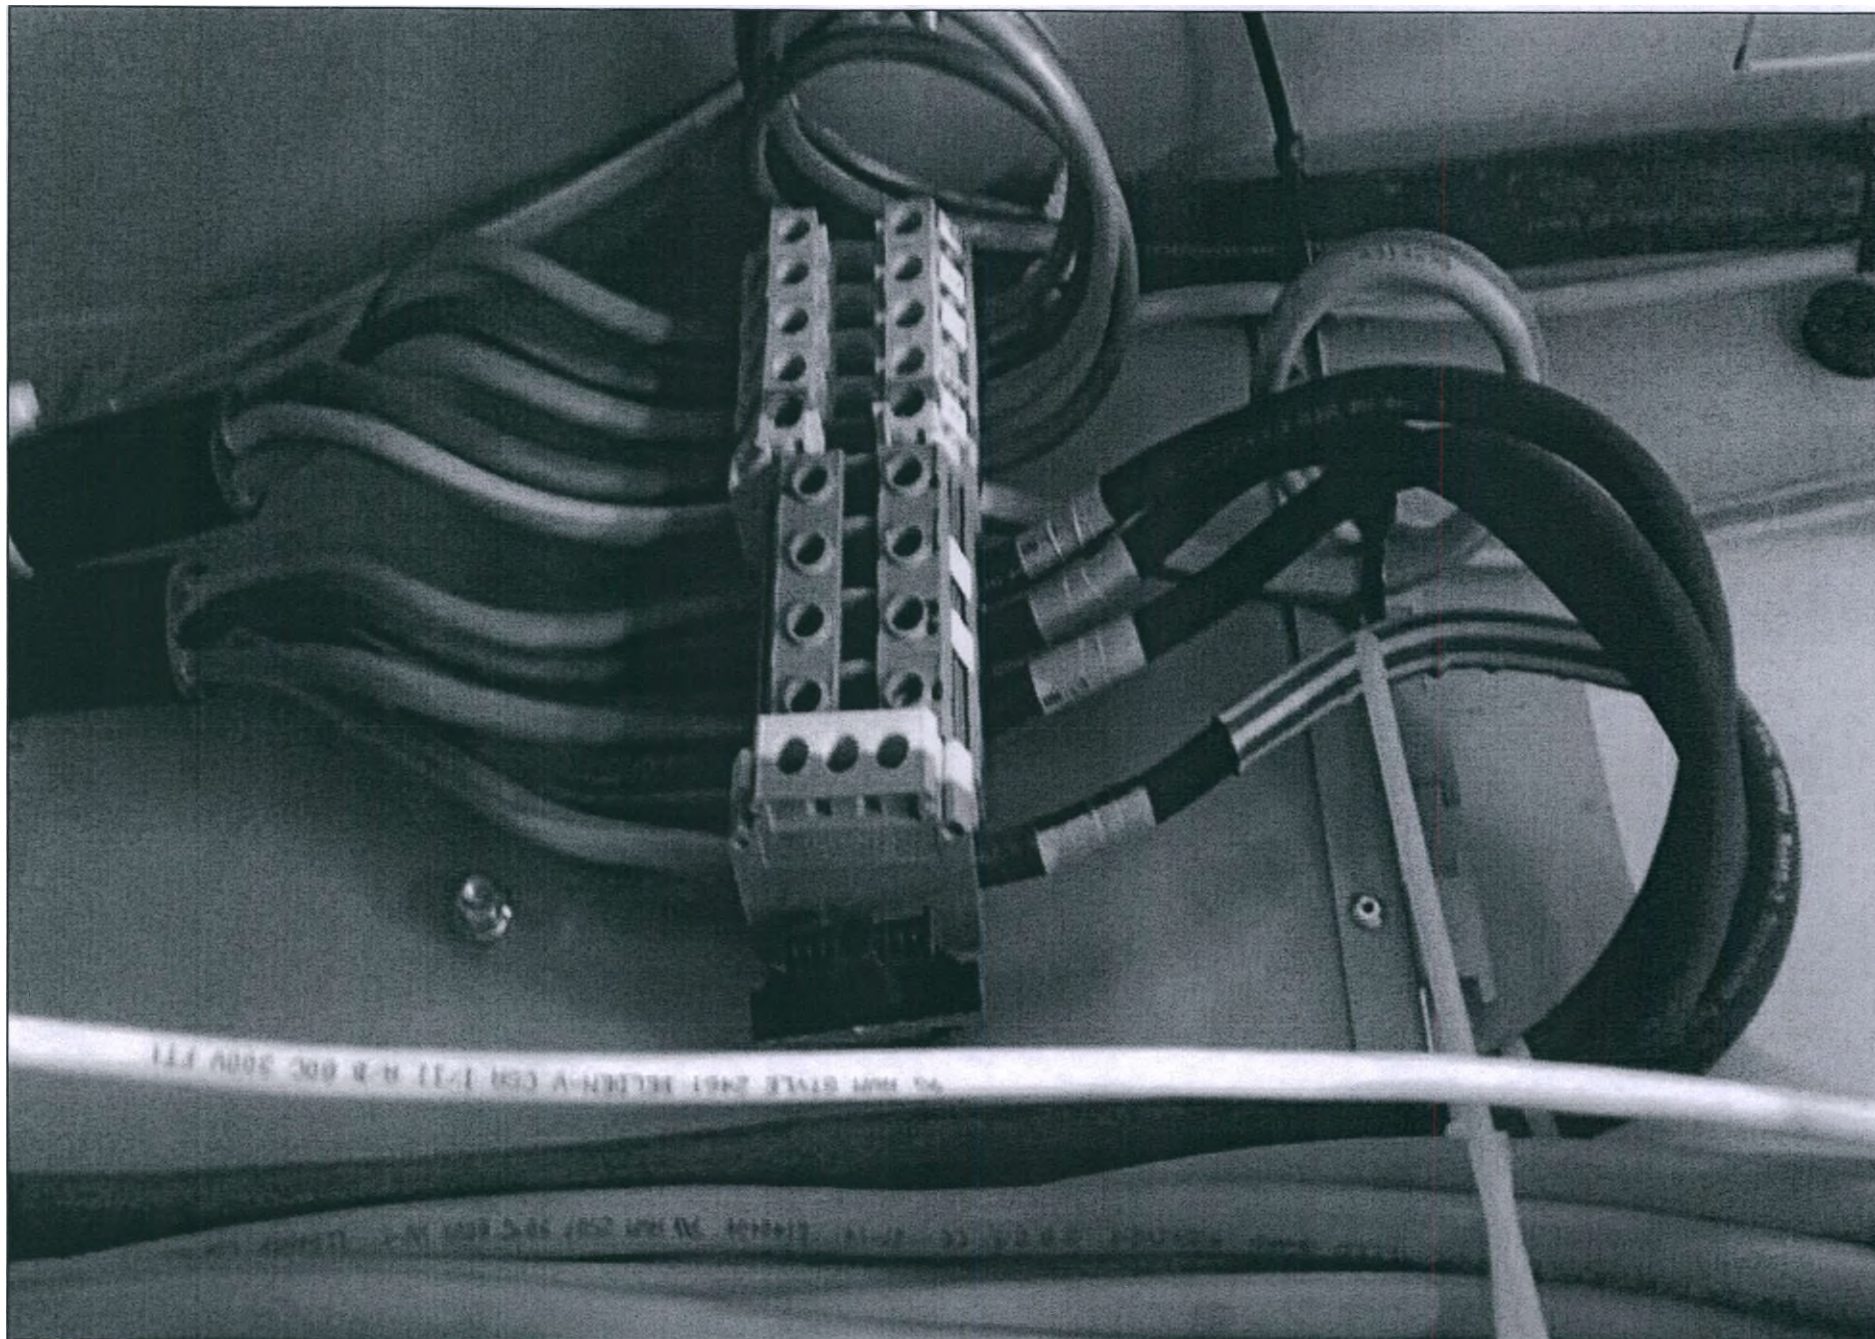

20. Кабели питания. 10 шт.

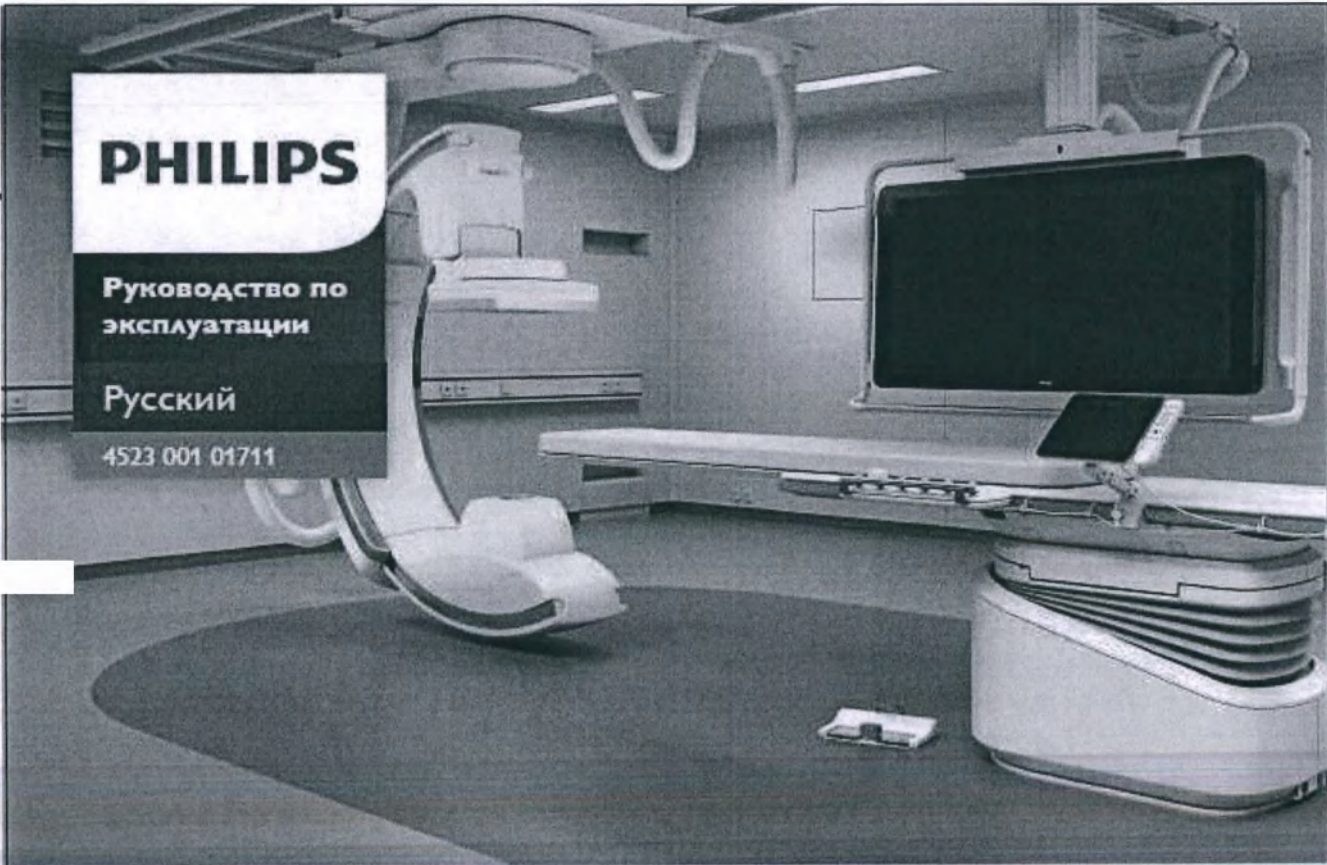

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский


4523 001 01711

Philips Azurion

Версия 2.2

21.. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 7 M20 (вариант 2):

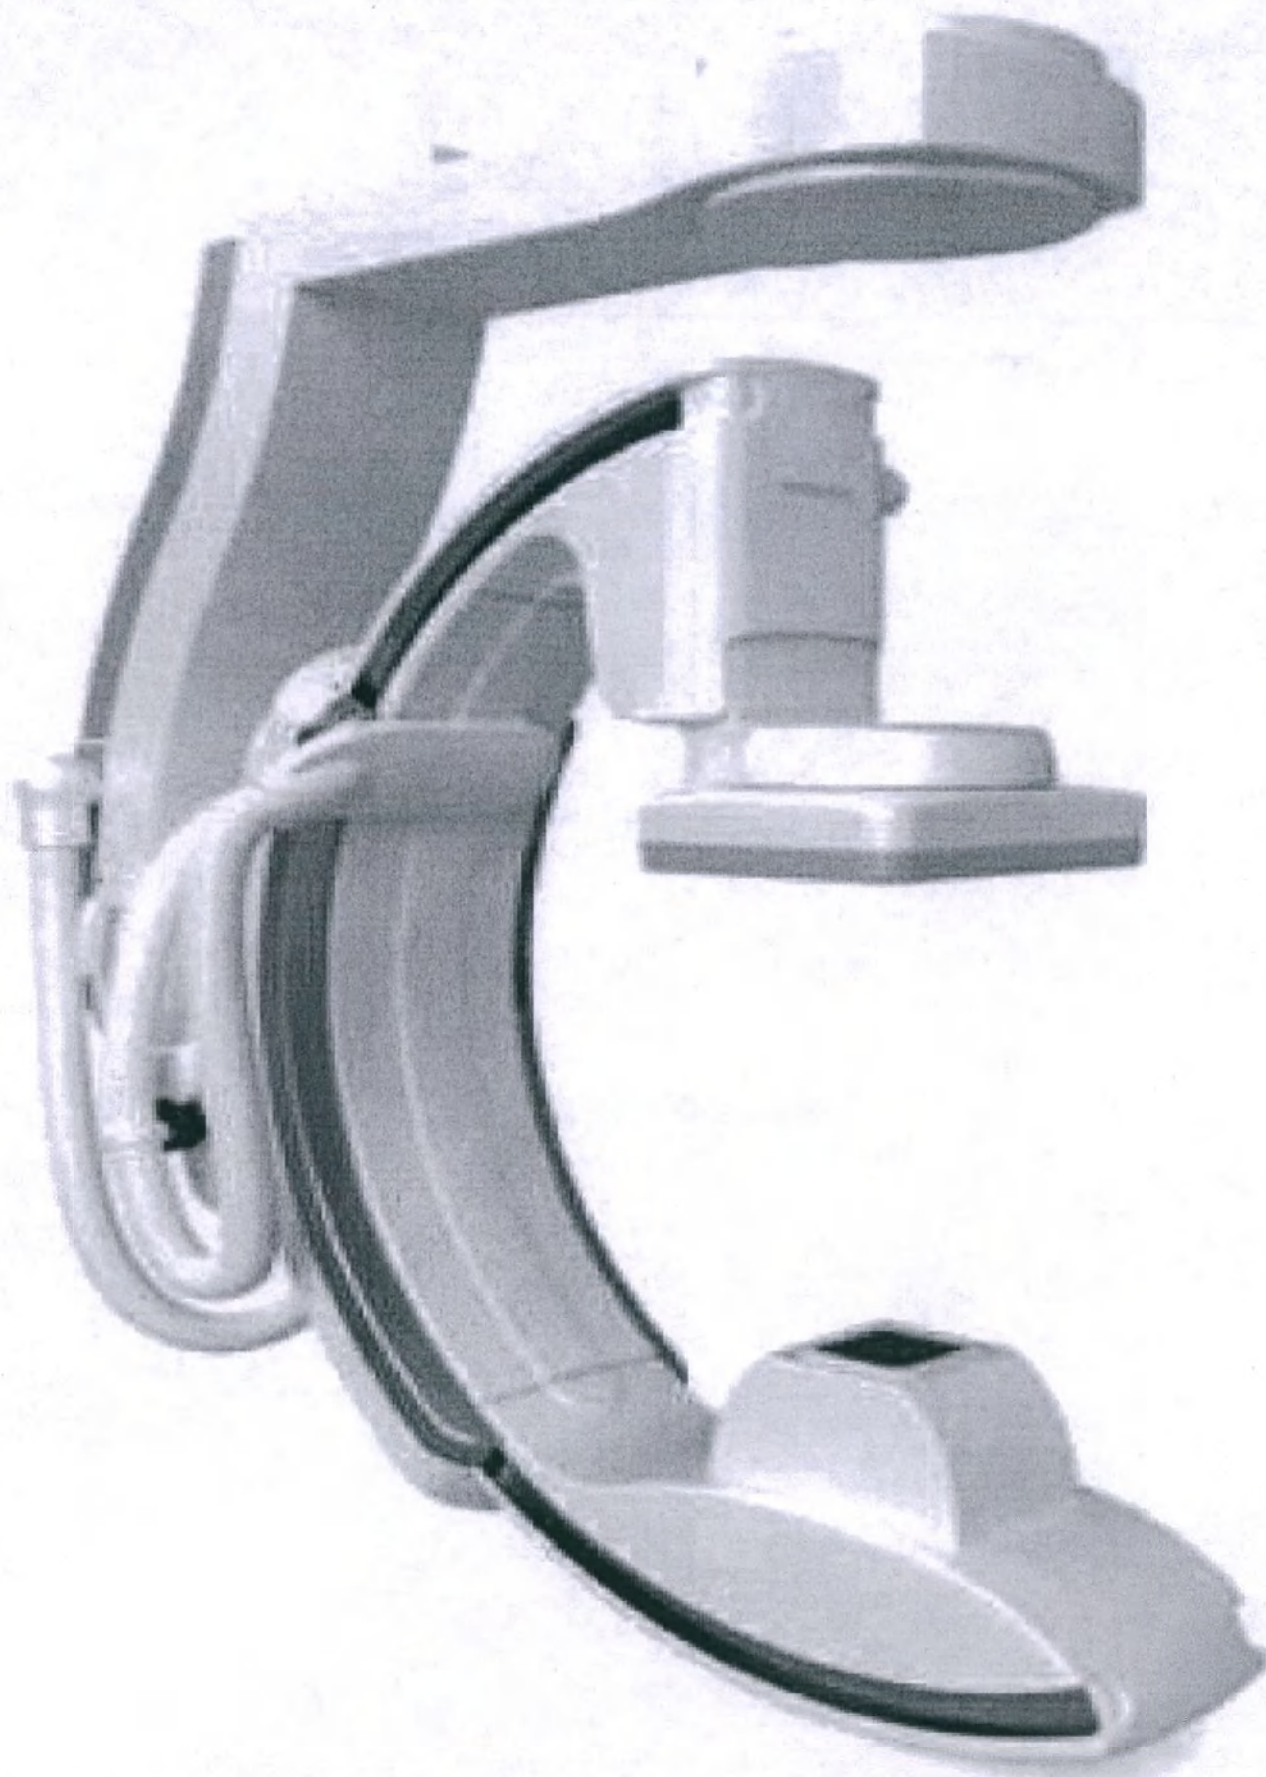


1. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C20.




1.а. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги (с опцией FlexArm); С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C20.

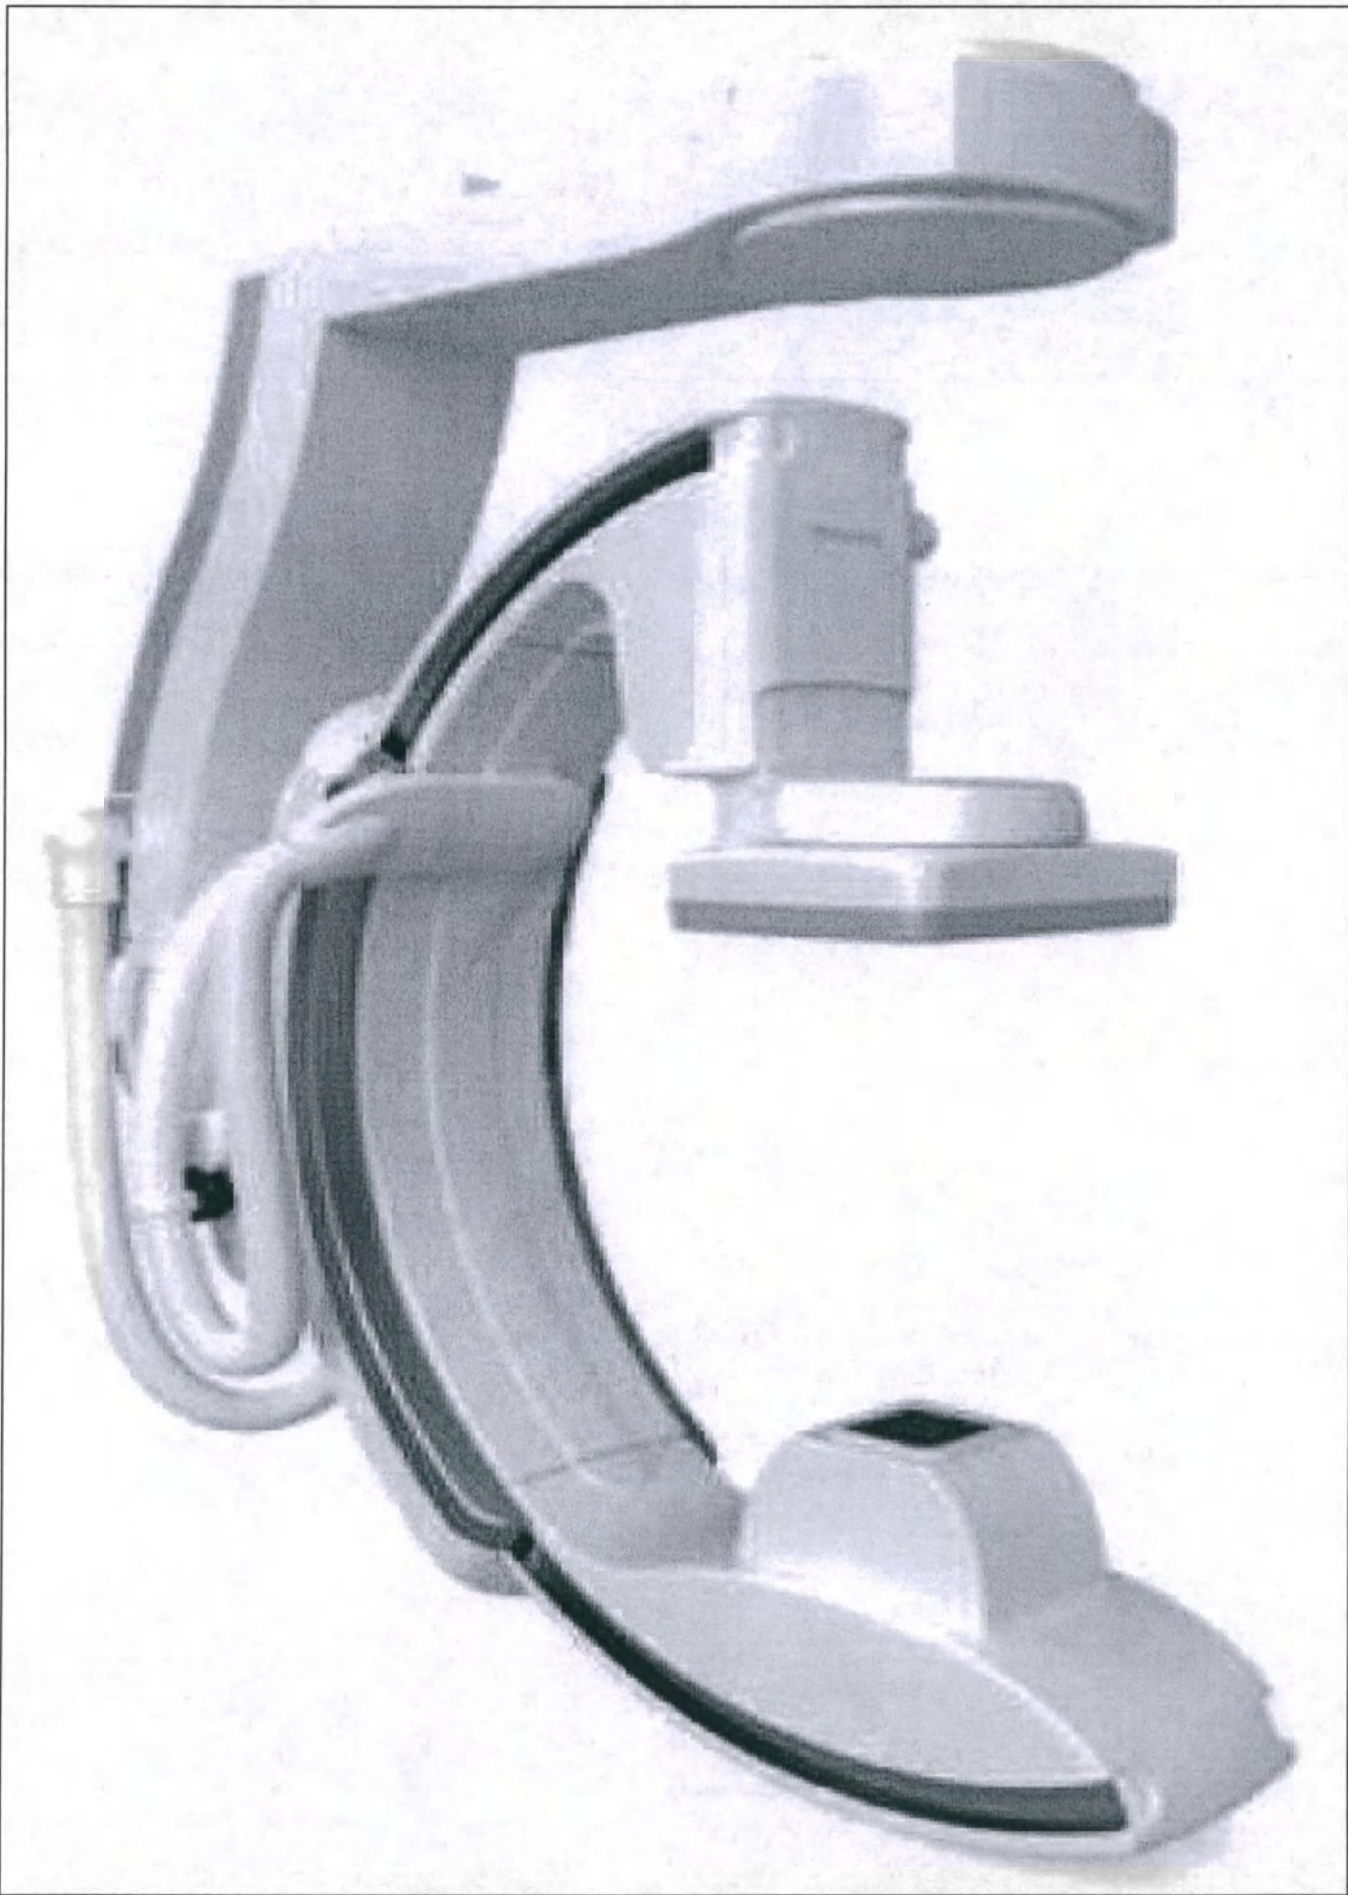


1.б. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

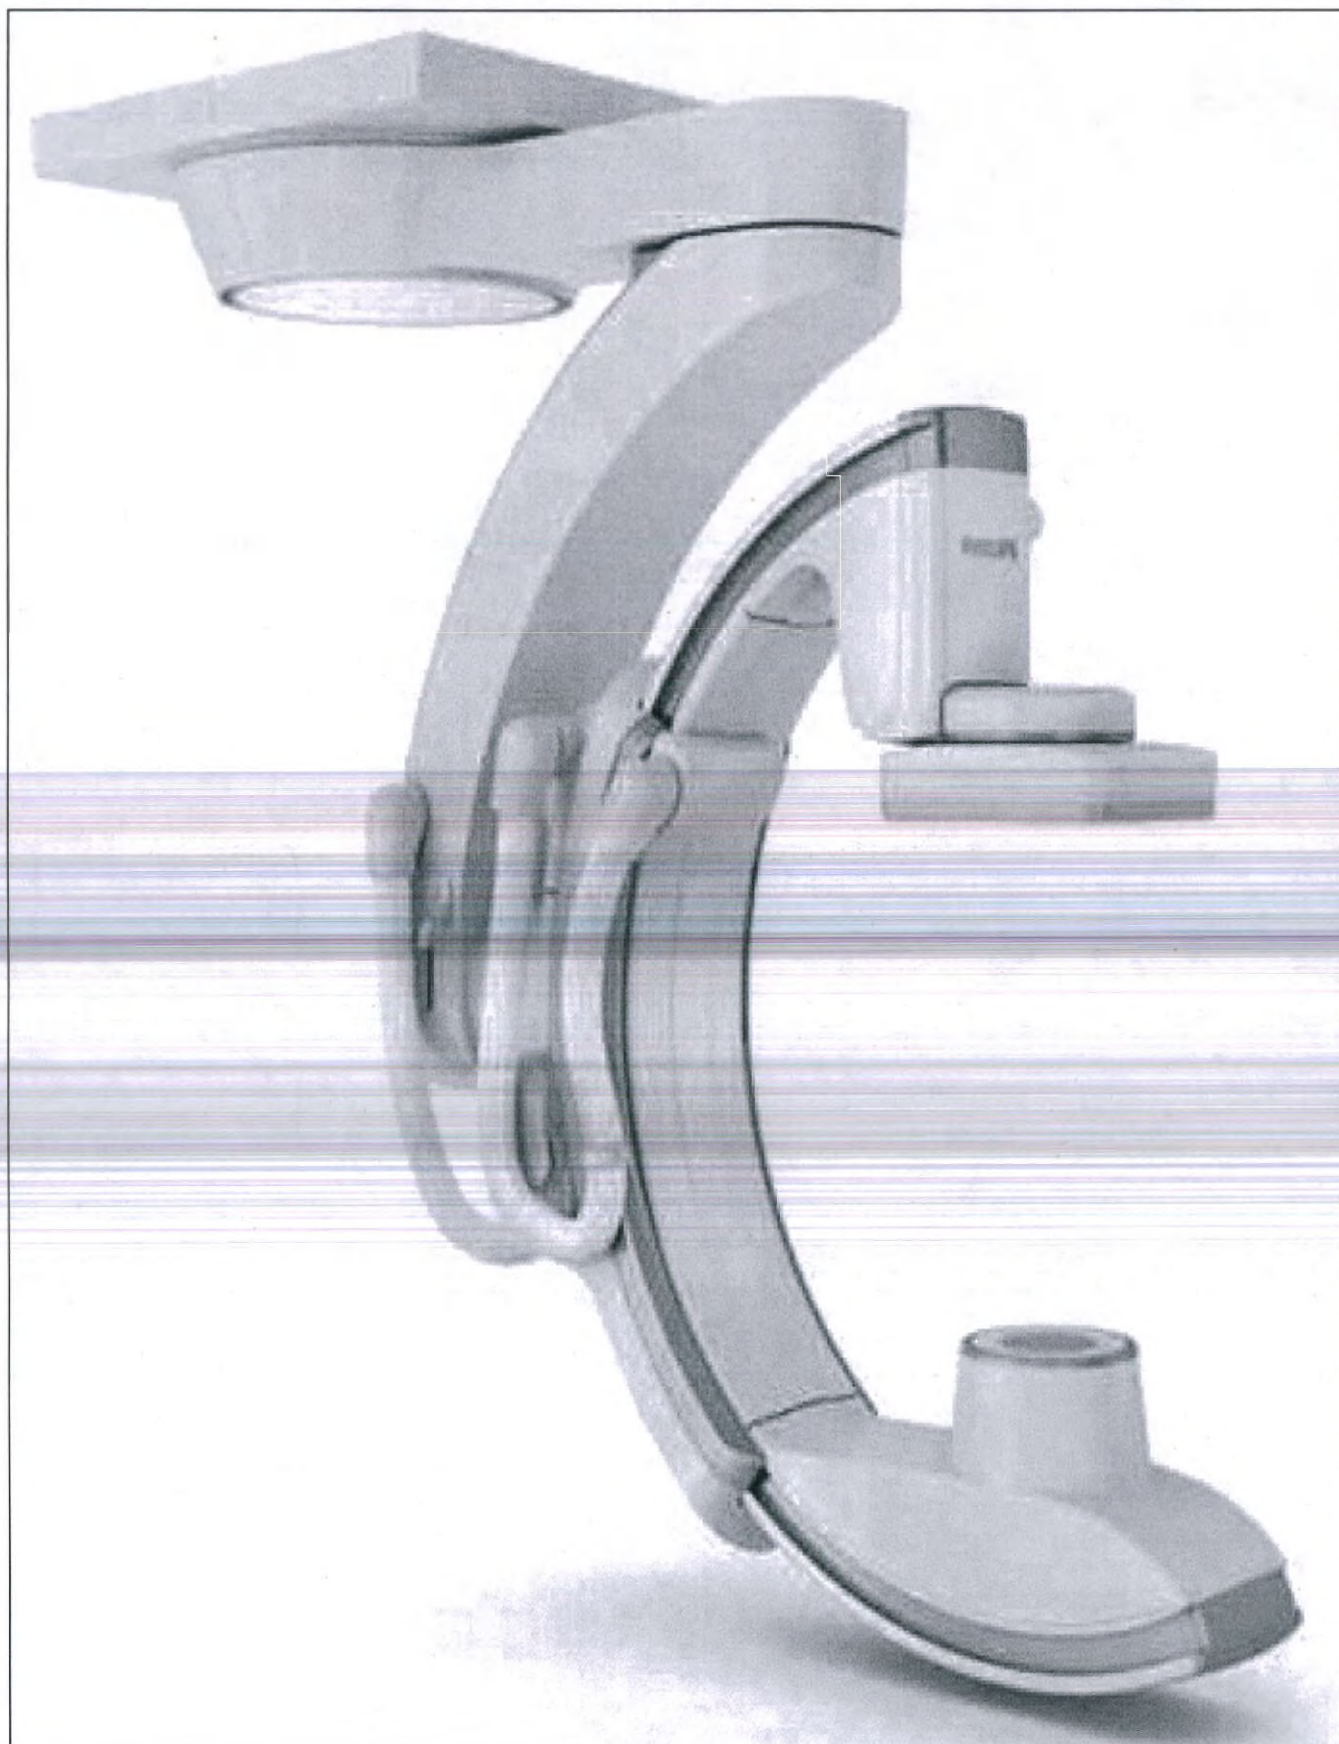


1.в. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга (с опцией FlexArm); рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C20.

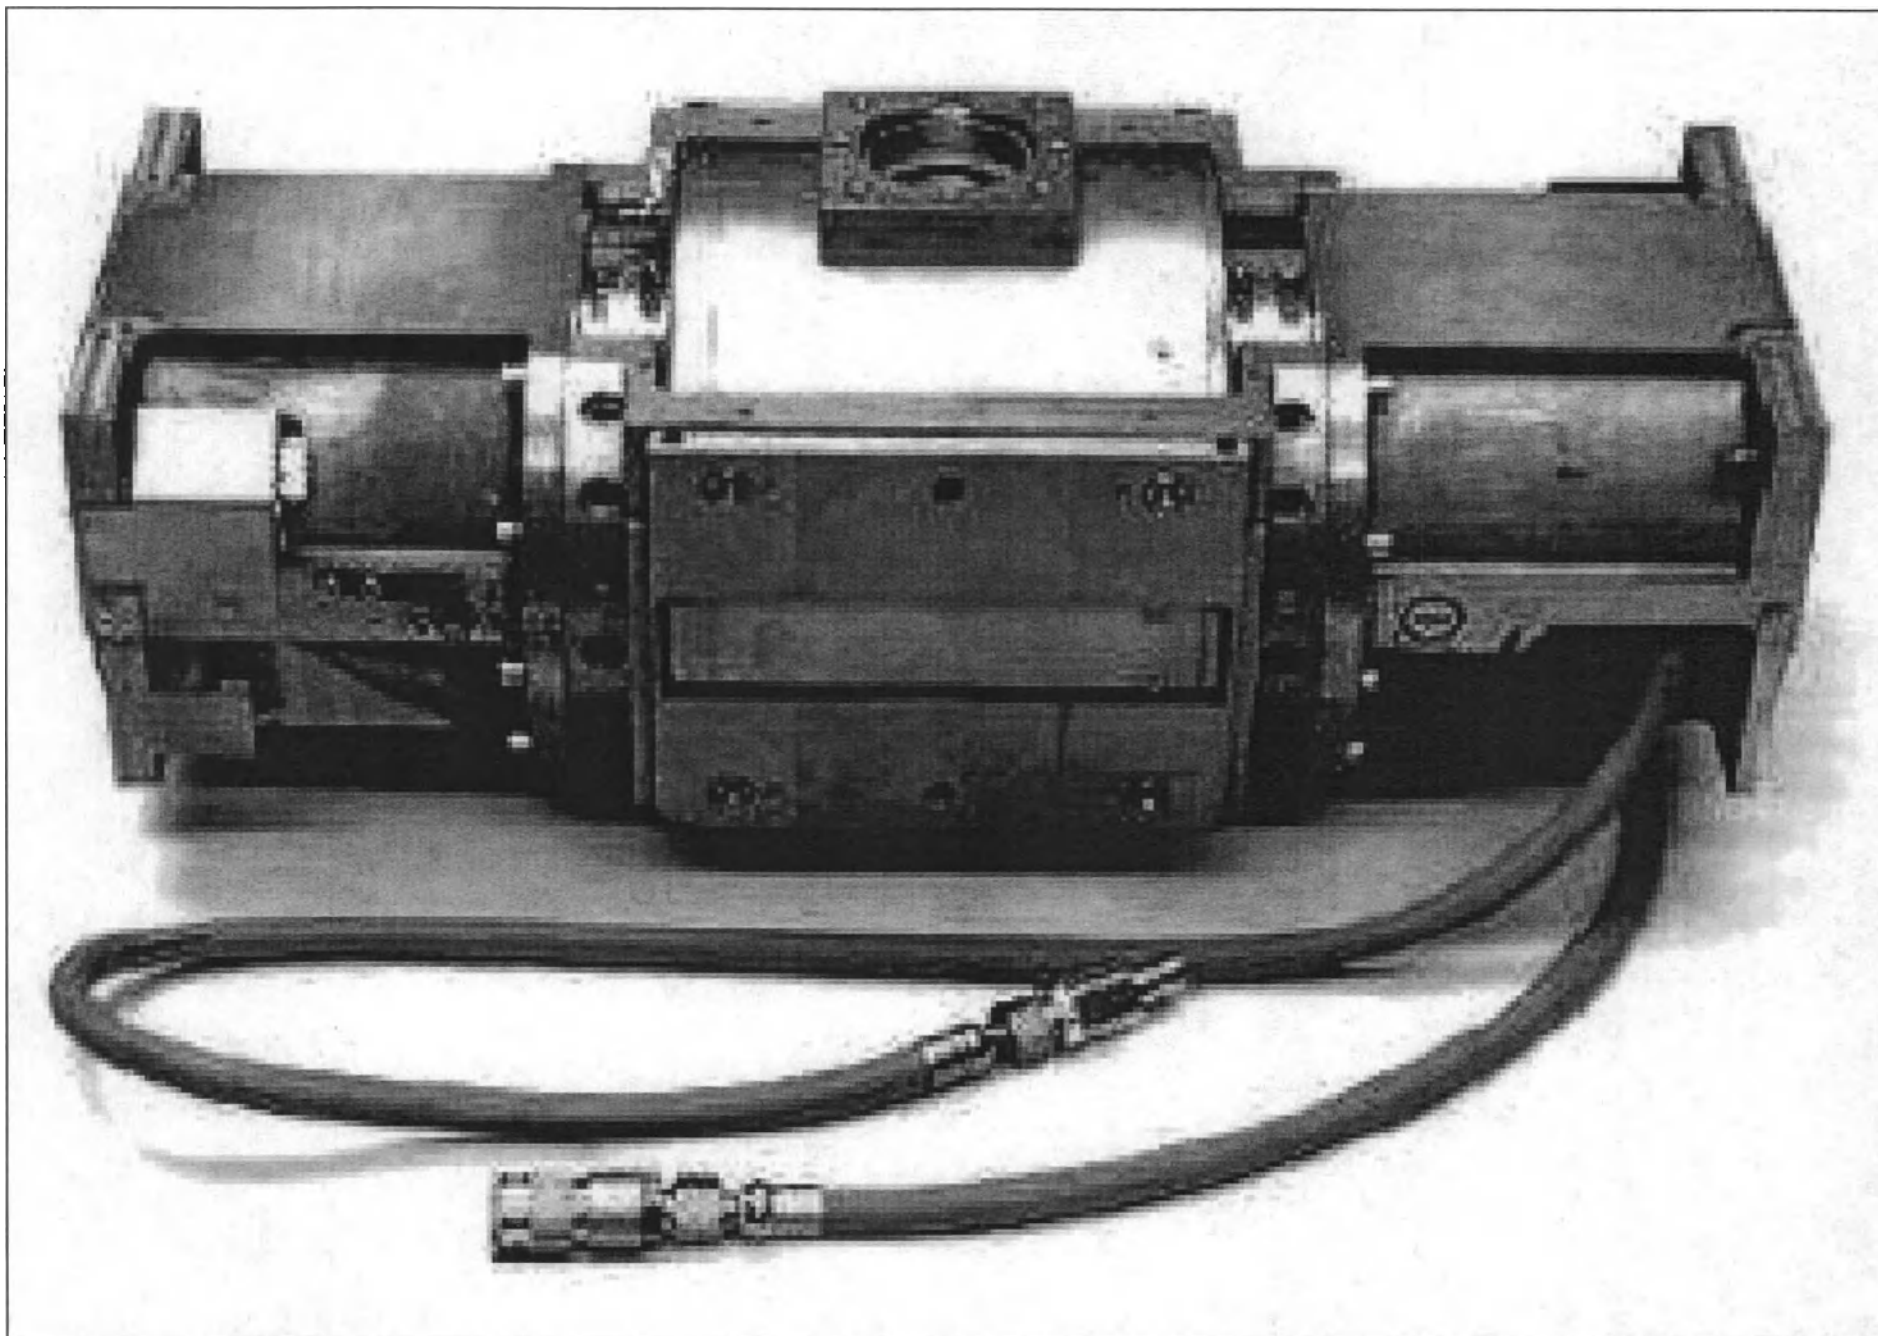


1.2. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

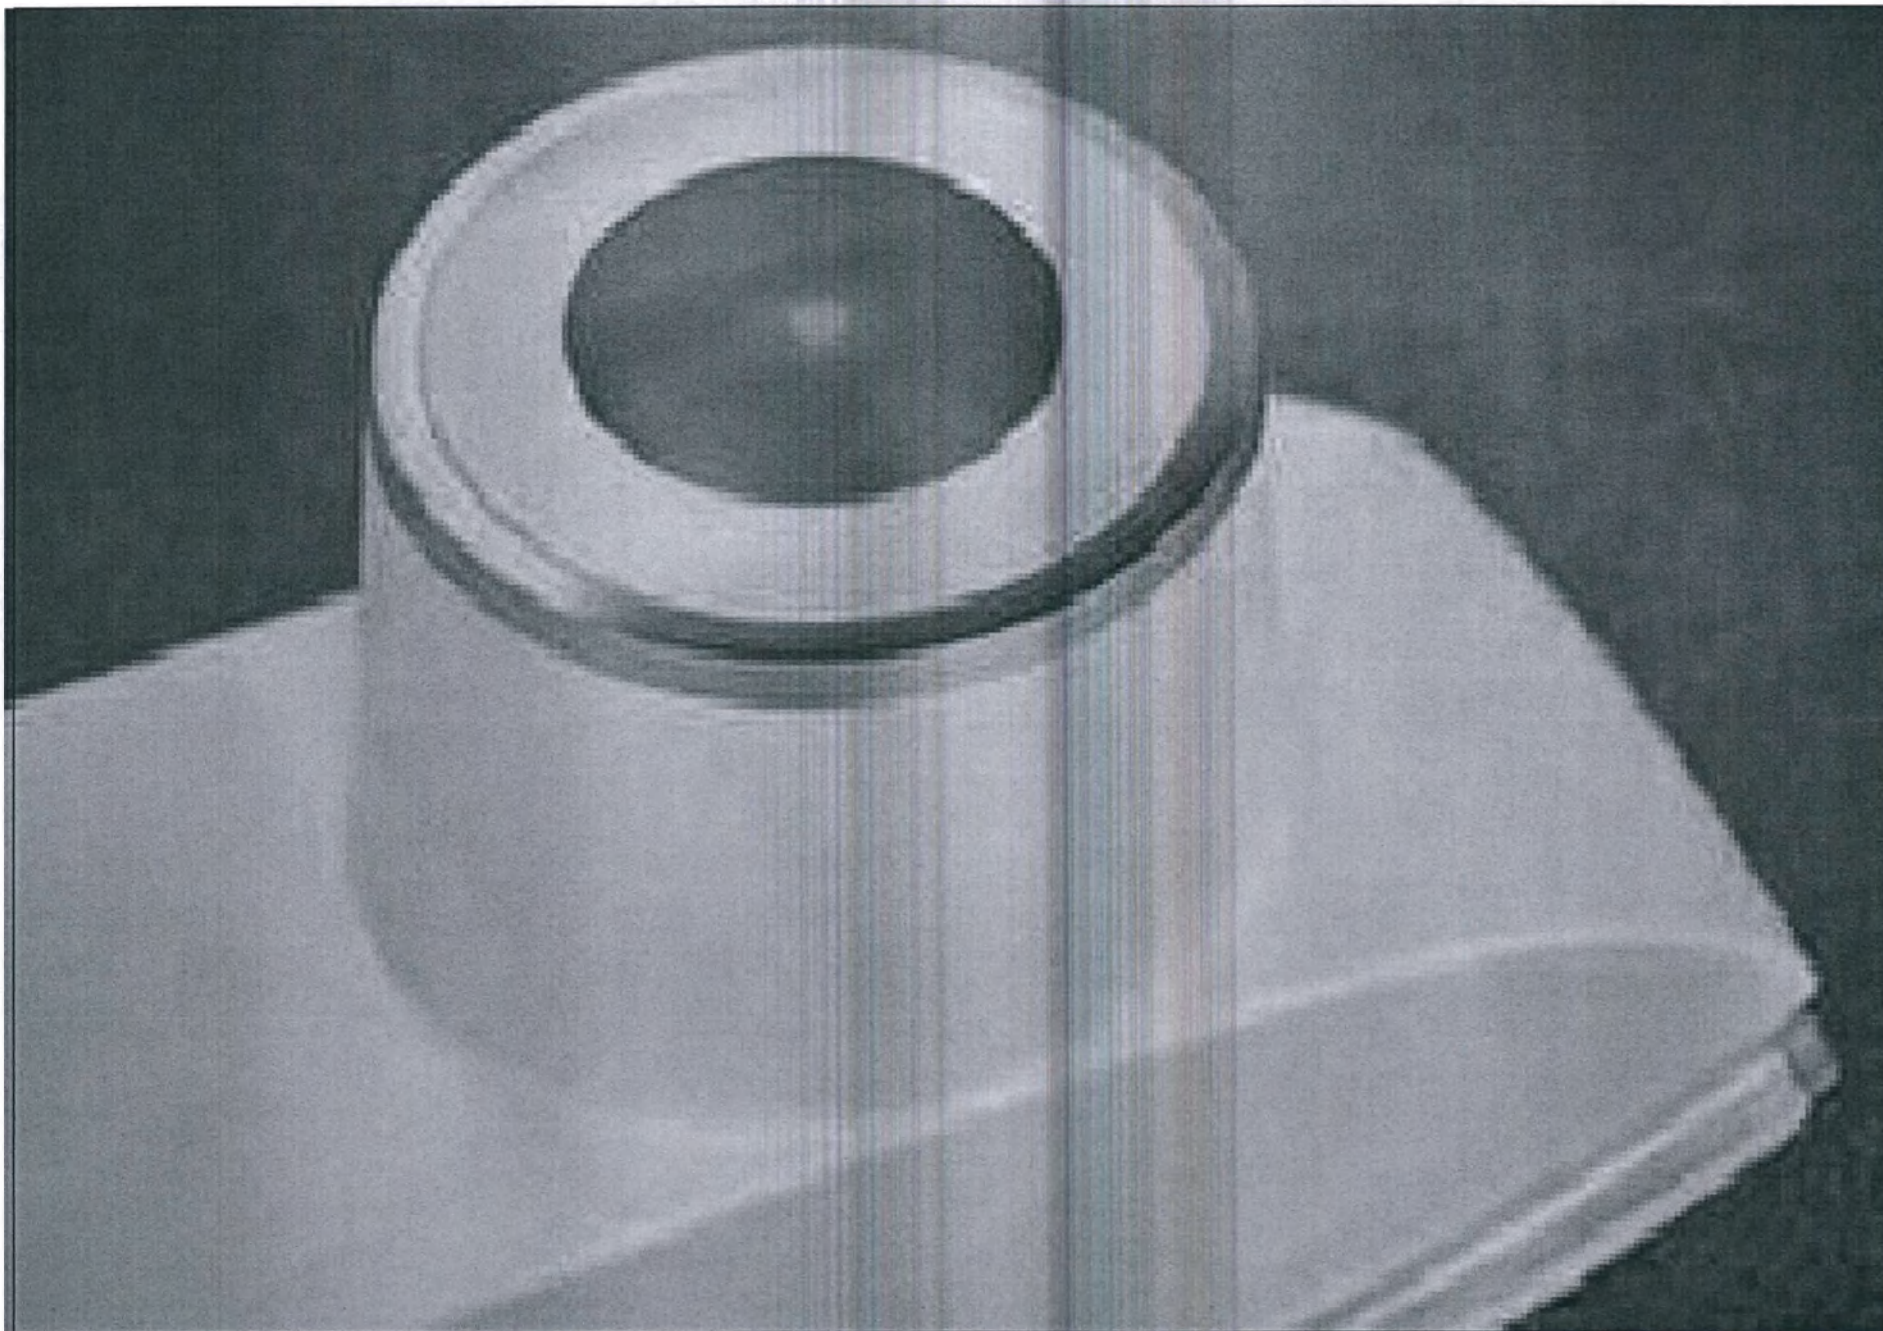


1.д. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

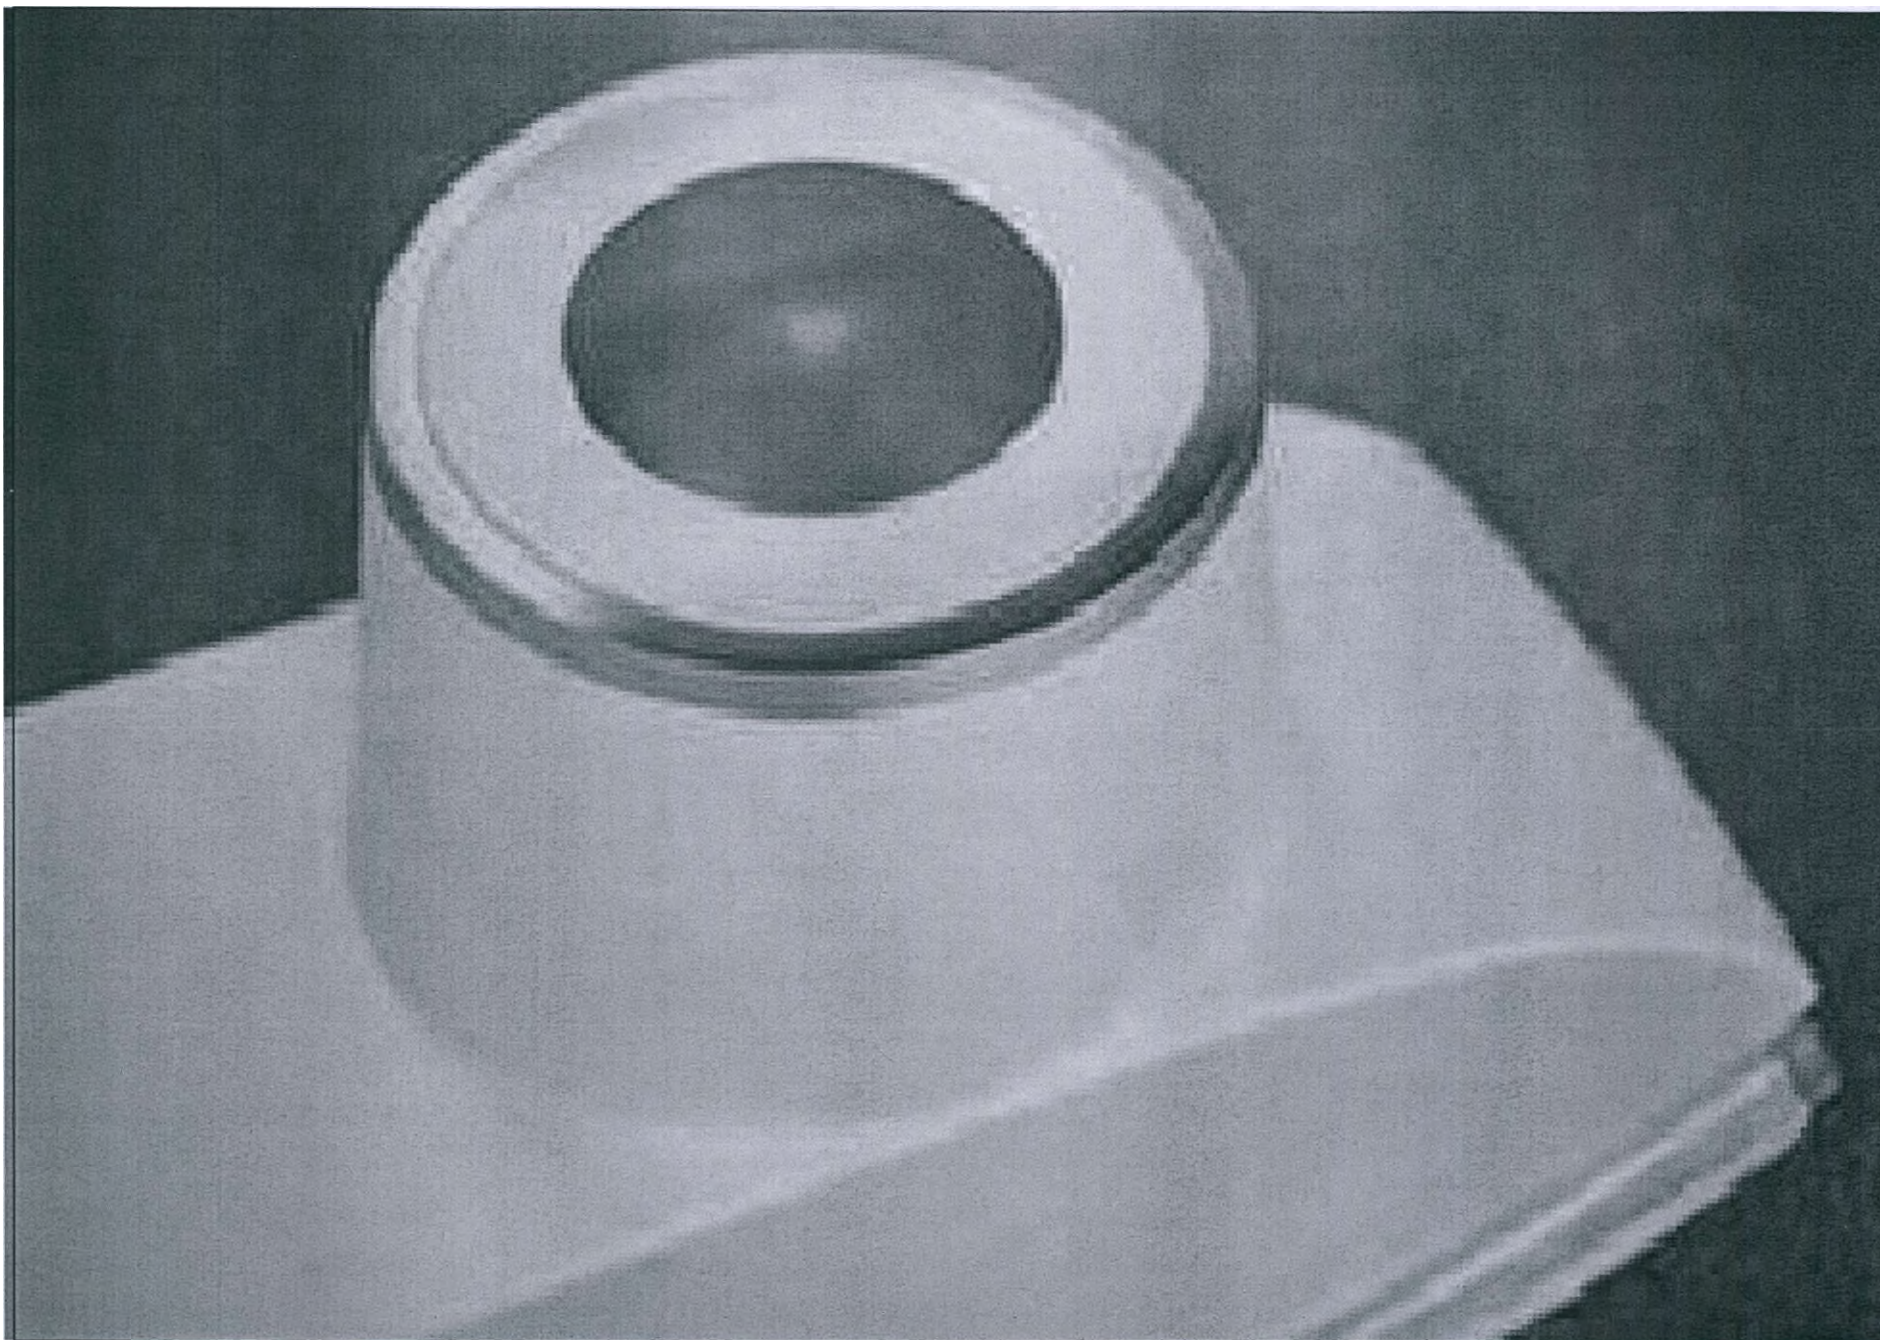


1.е. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

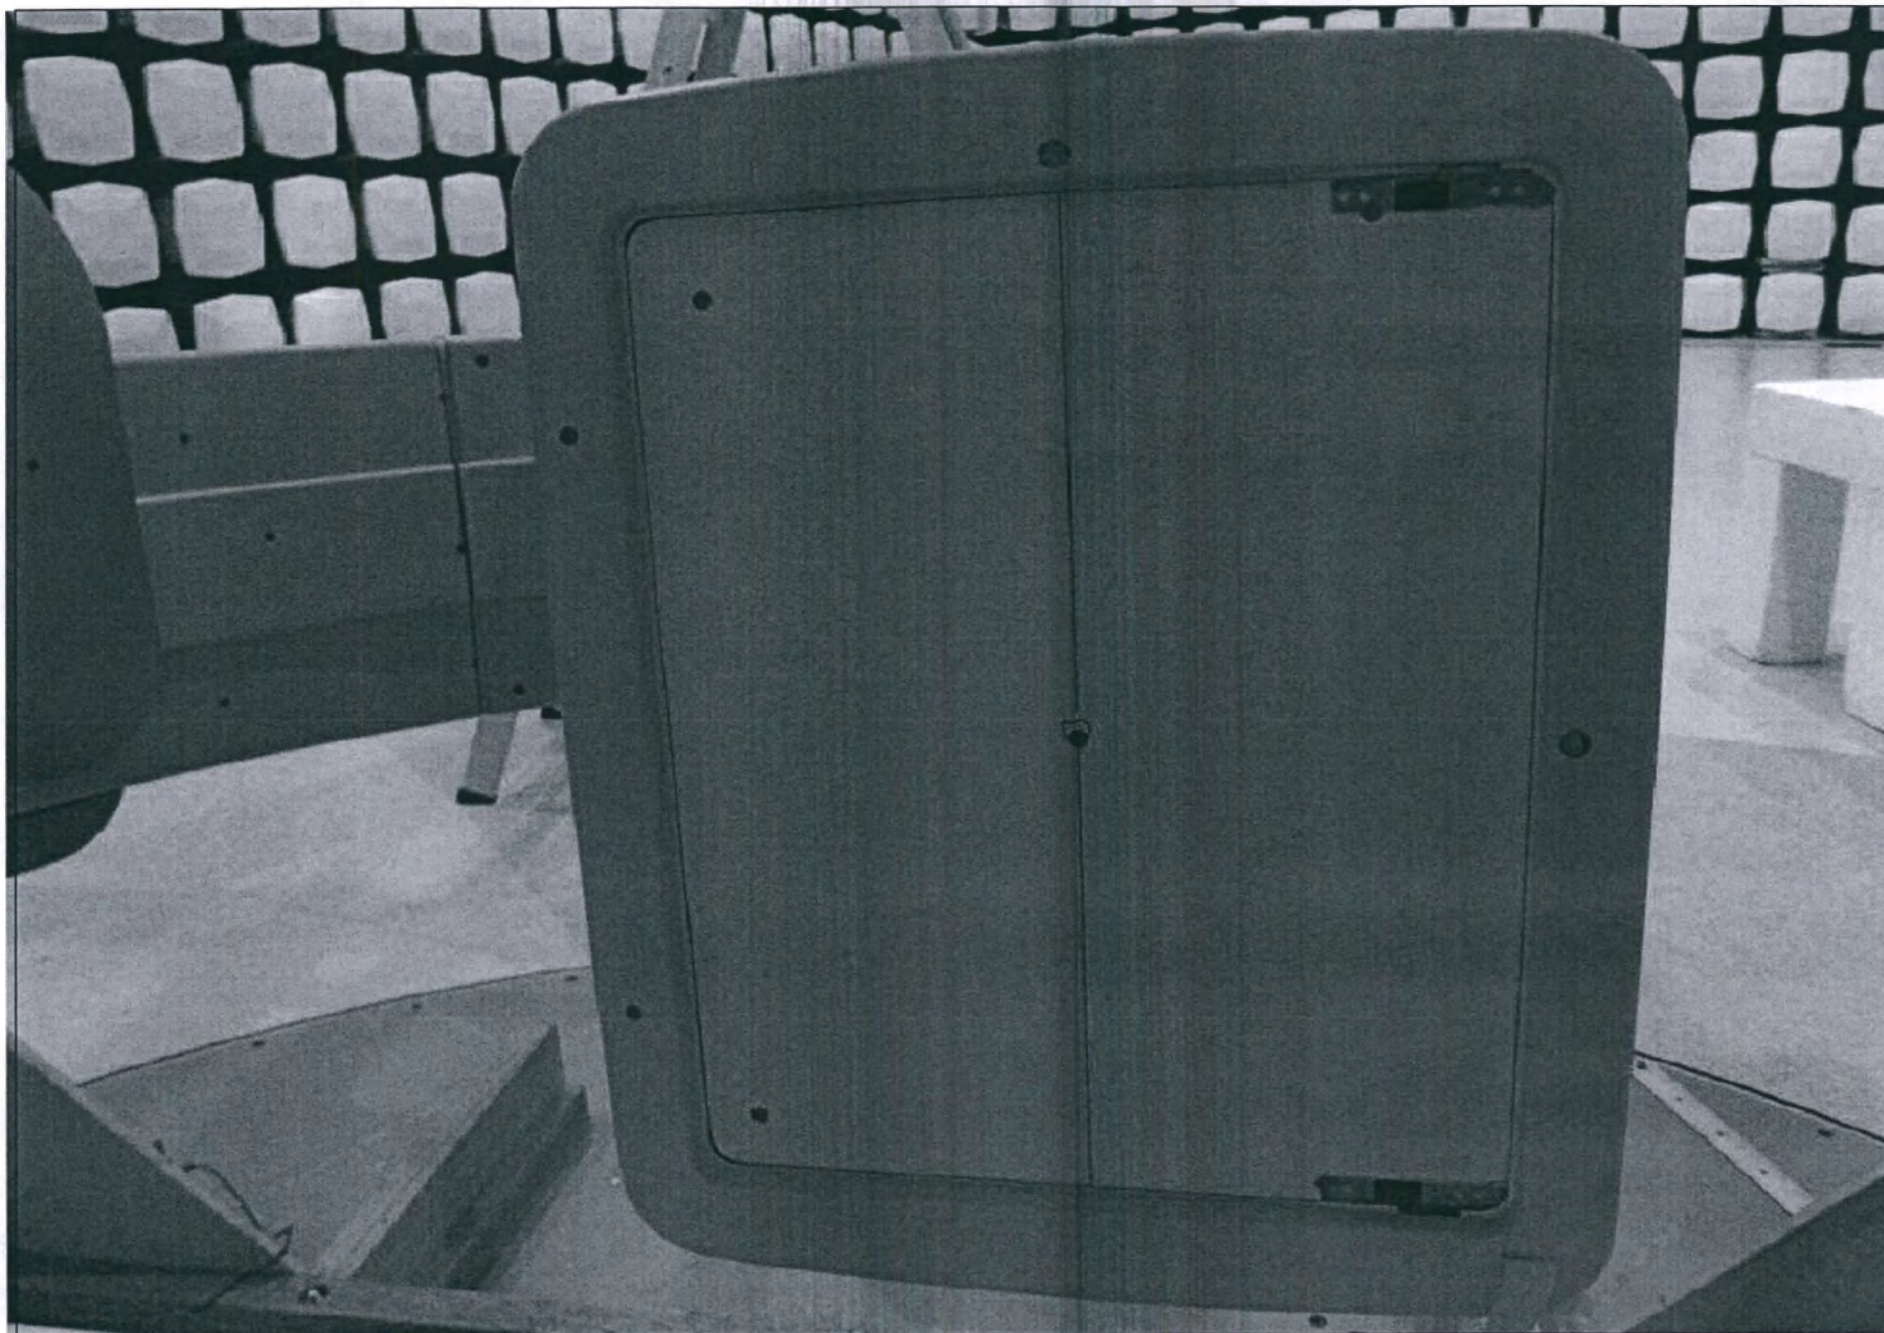


1.ж. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

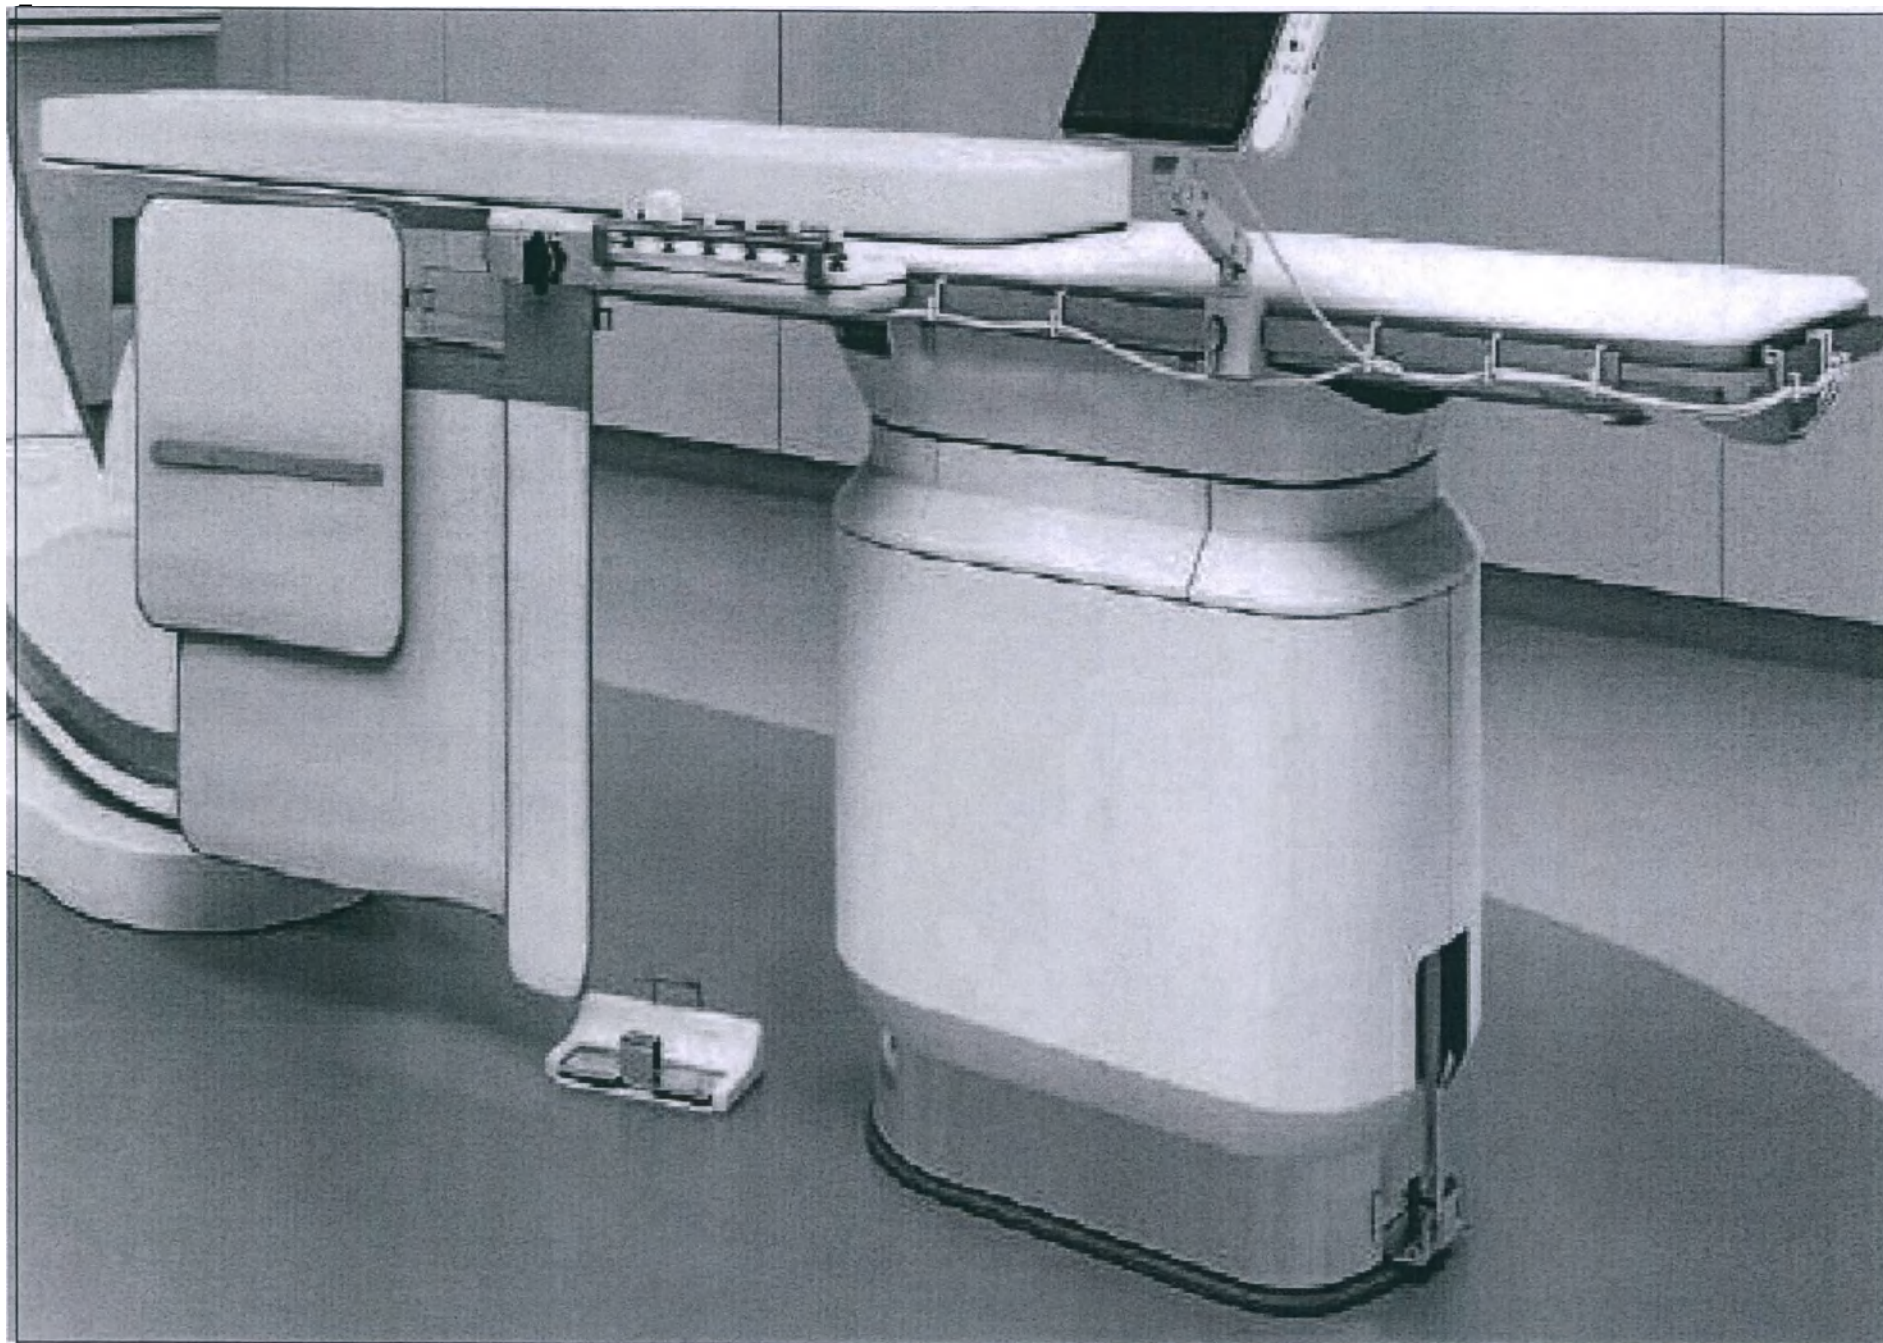


2.а. Стол пациента, варианты исполнения: *Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.*

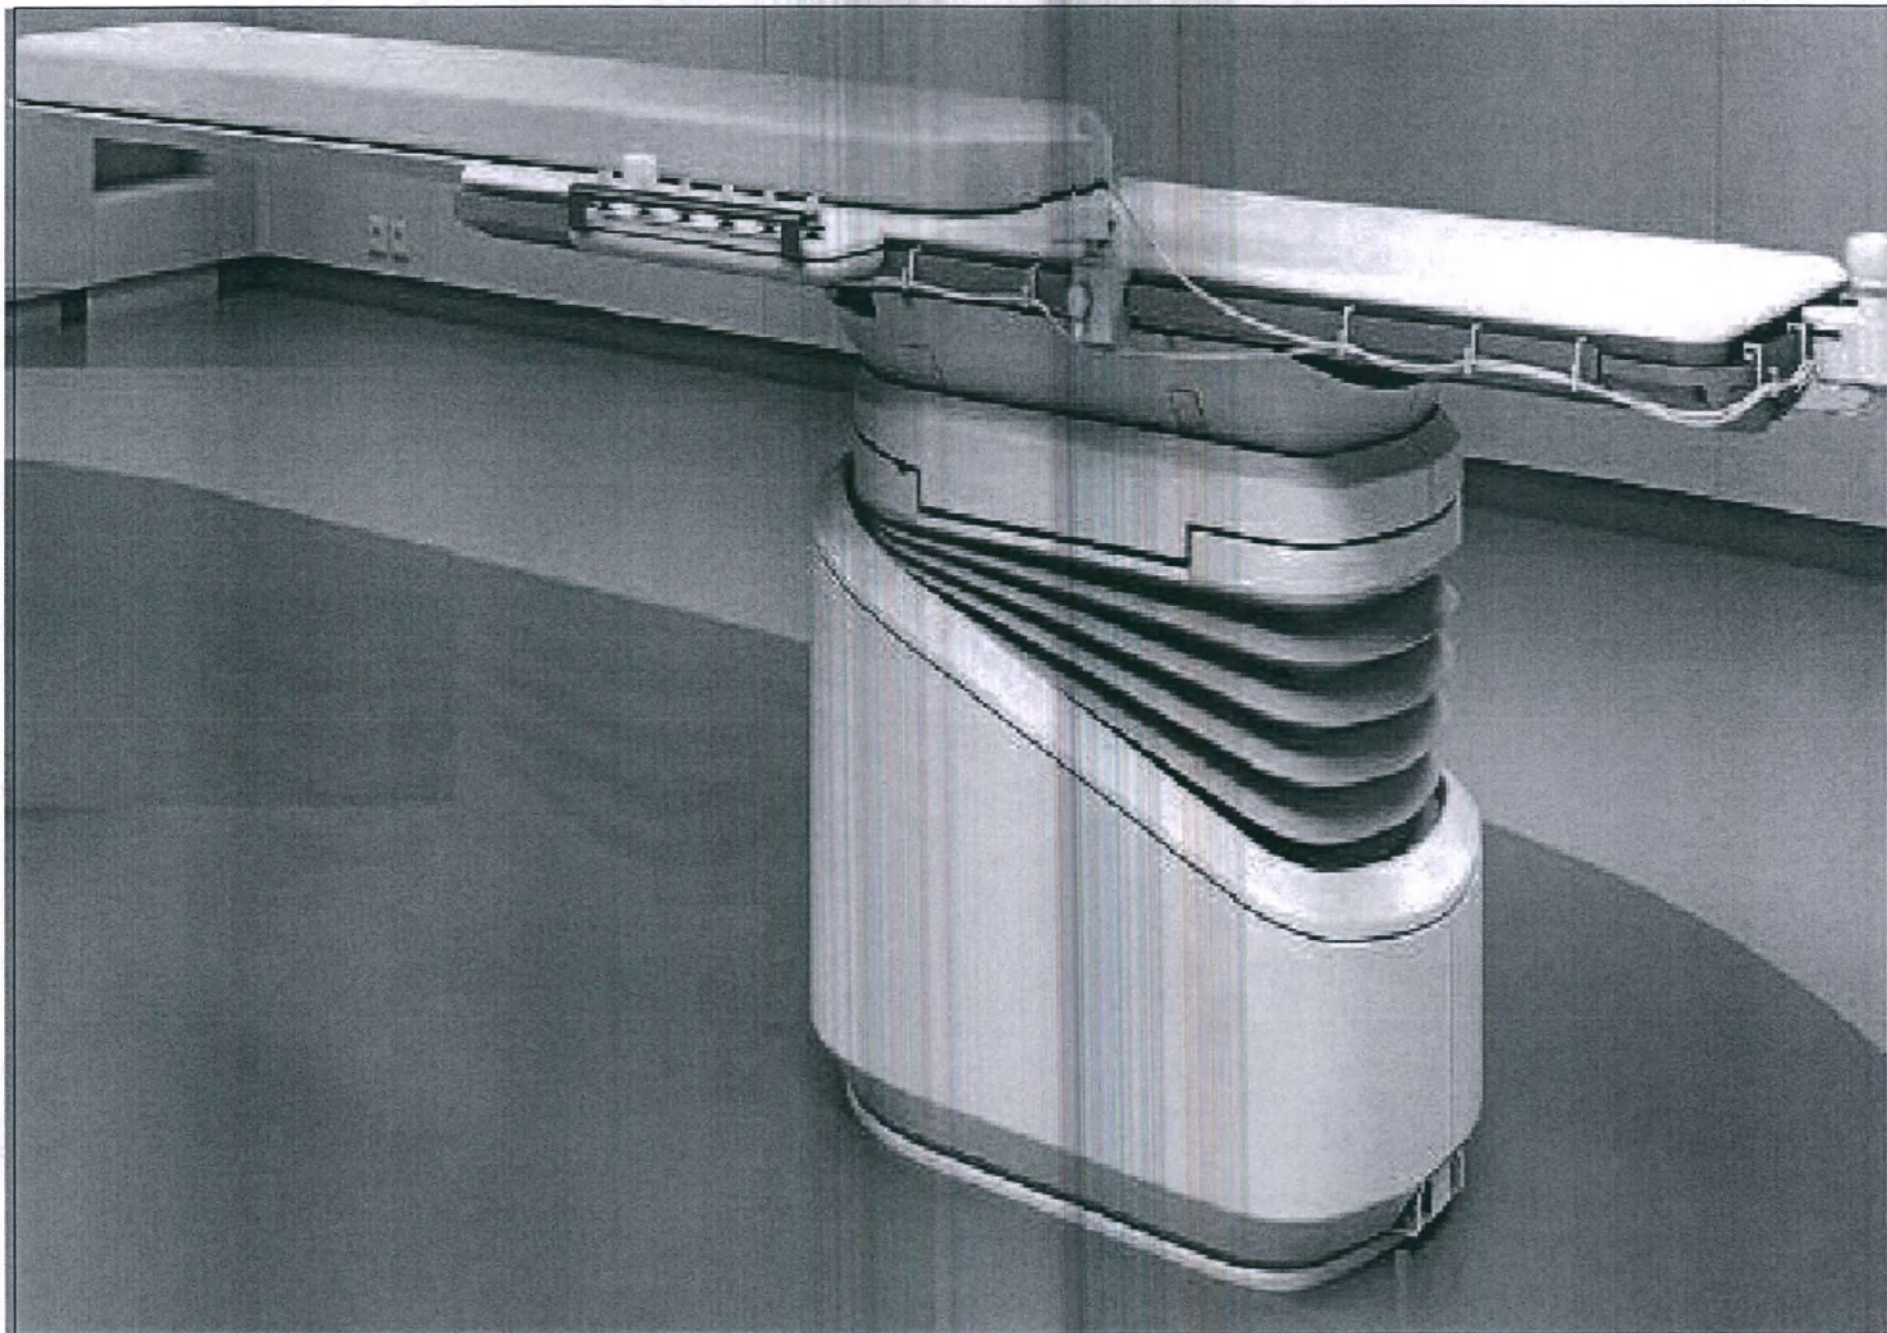


2.6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

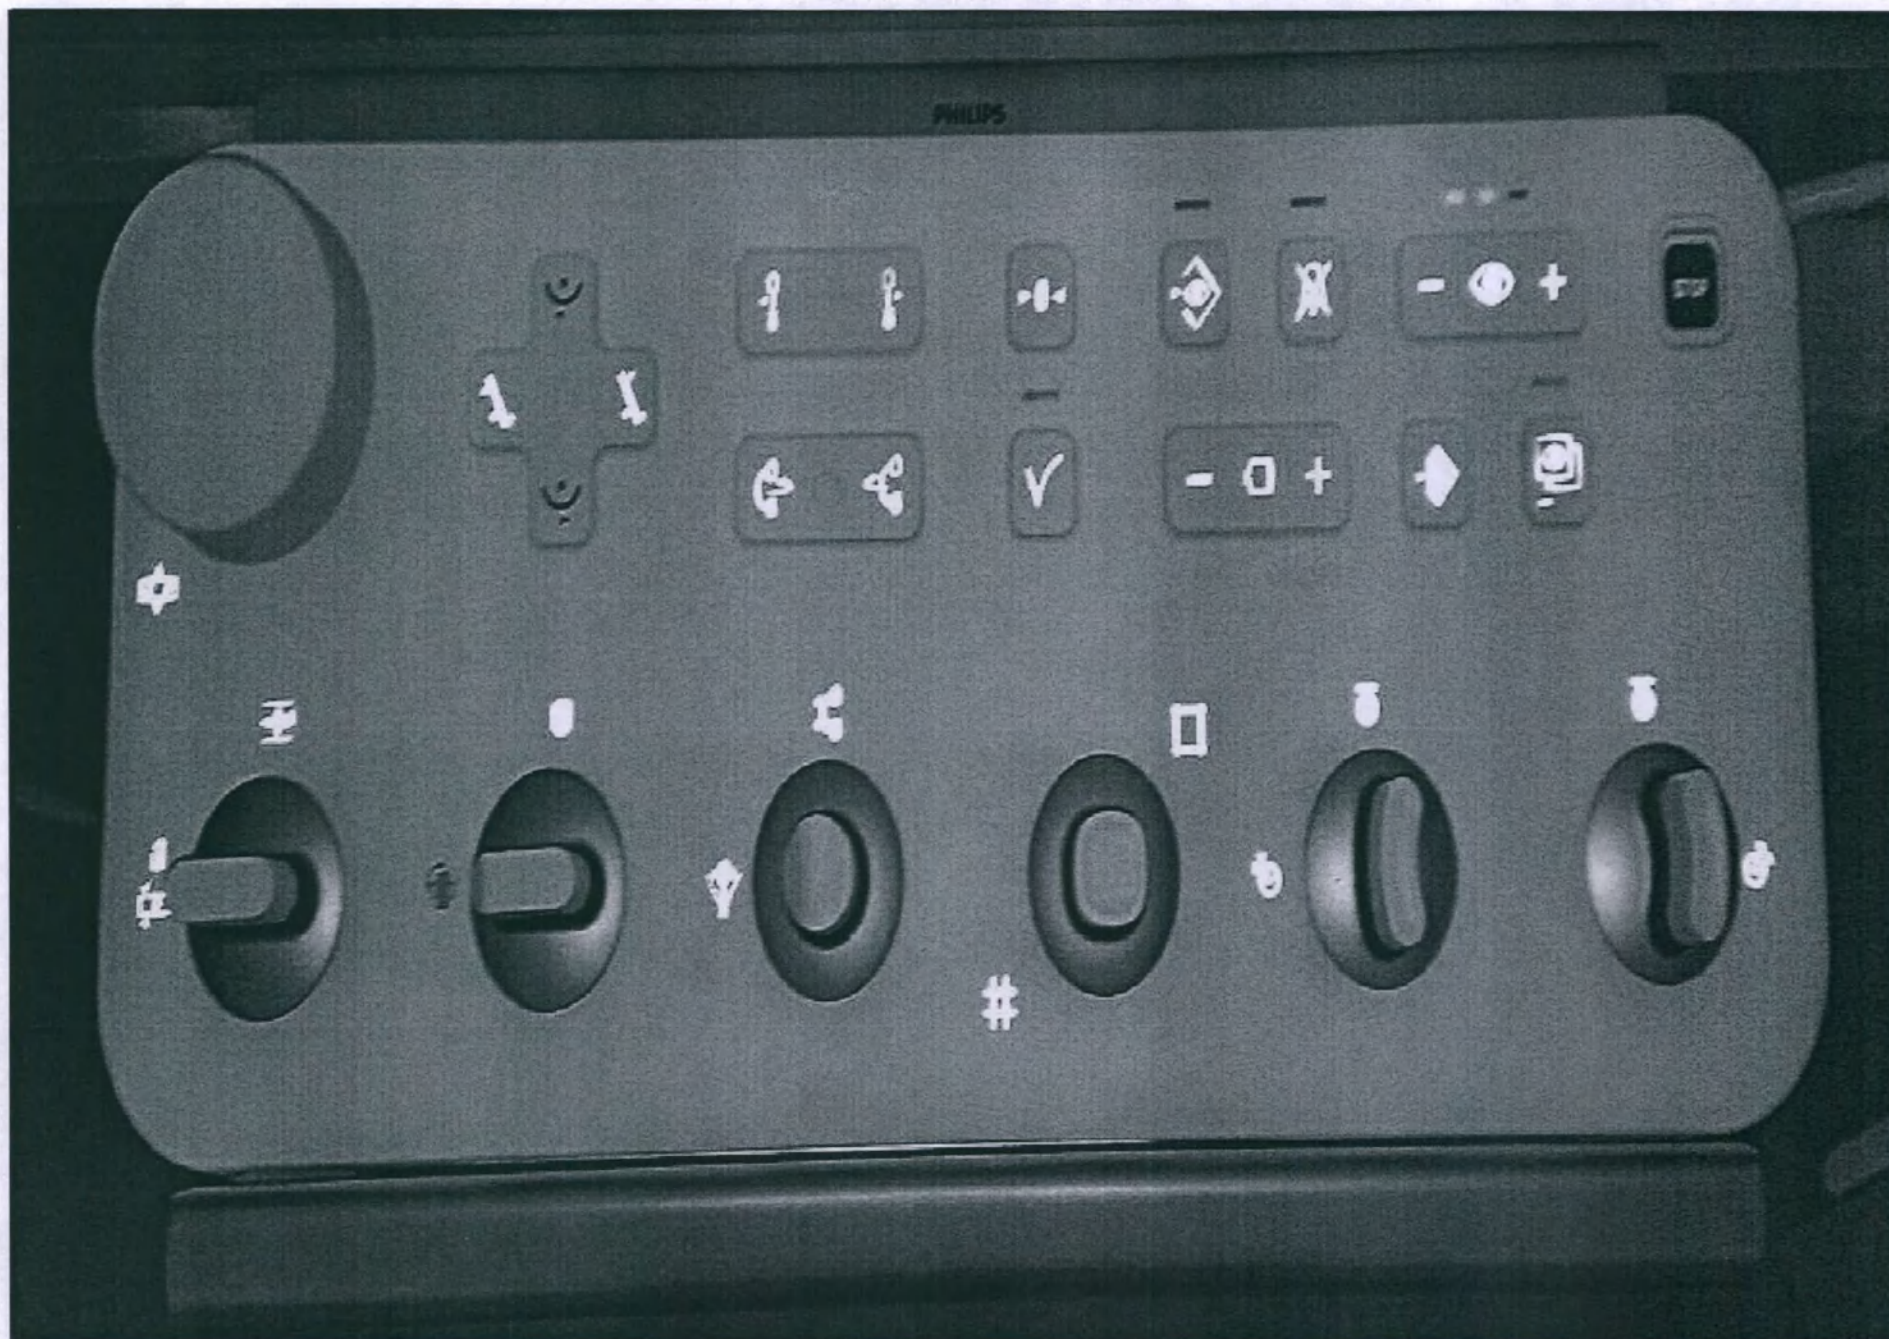


3.а. Модуль управления, не более 4 шт.

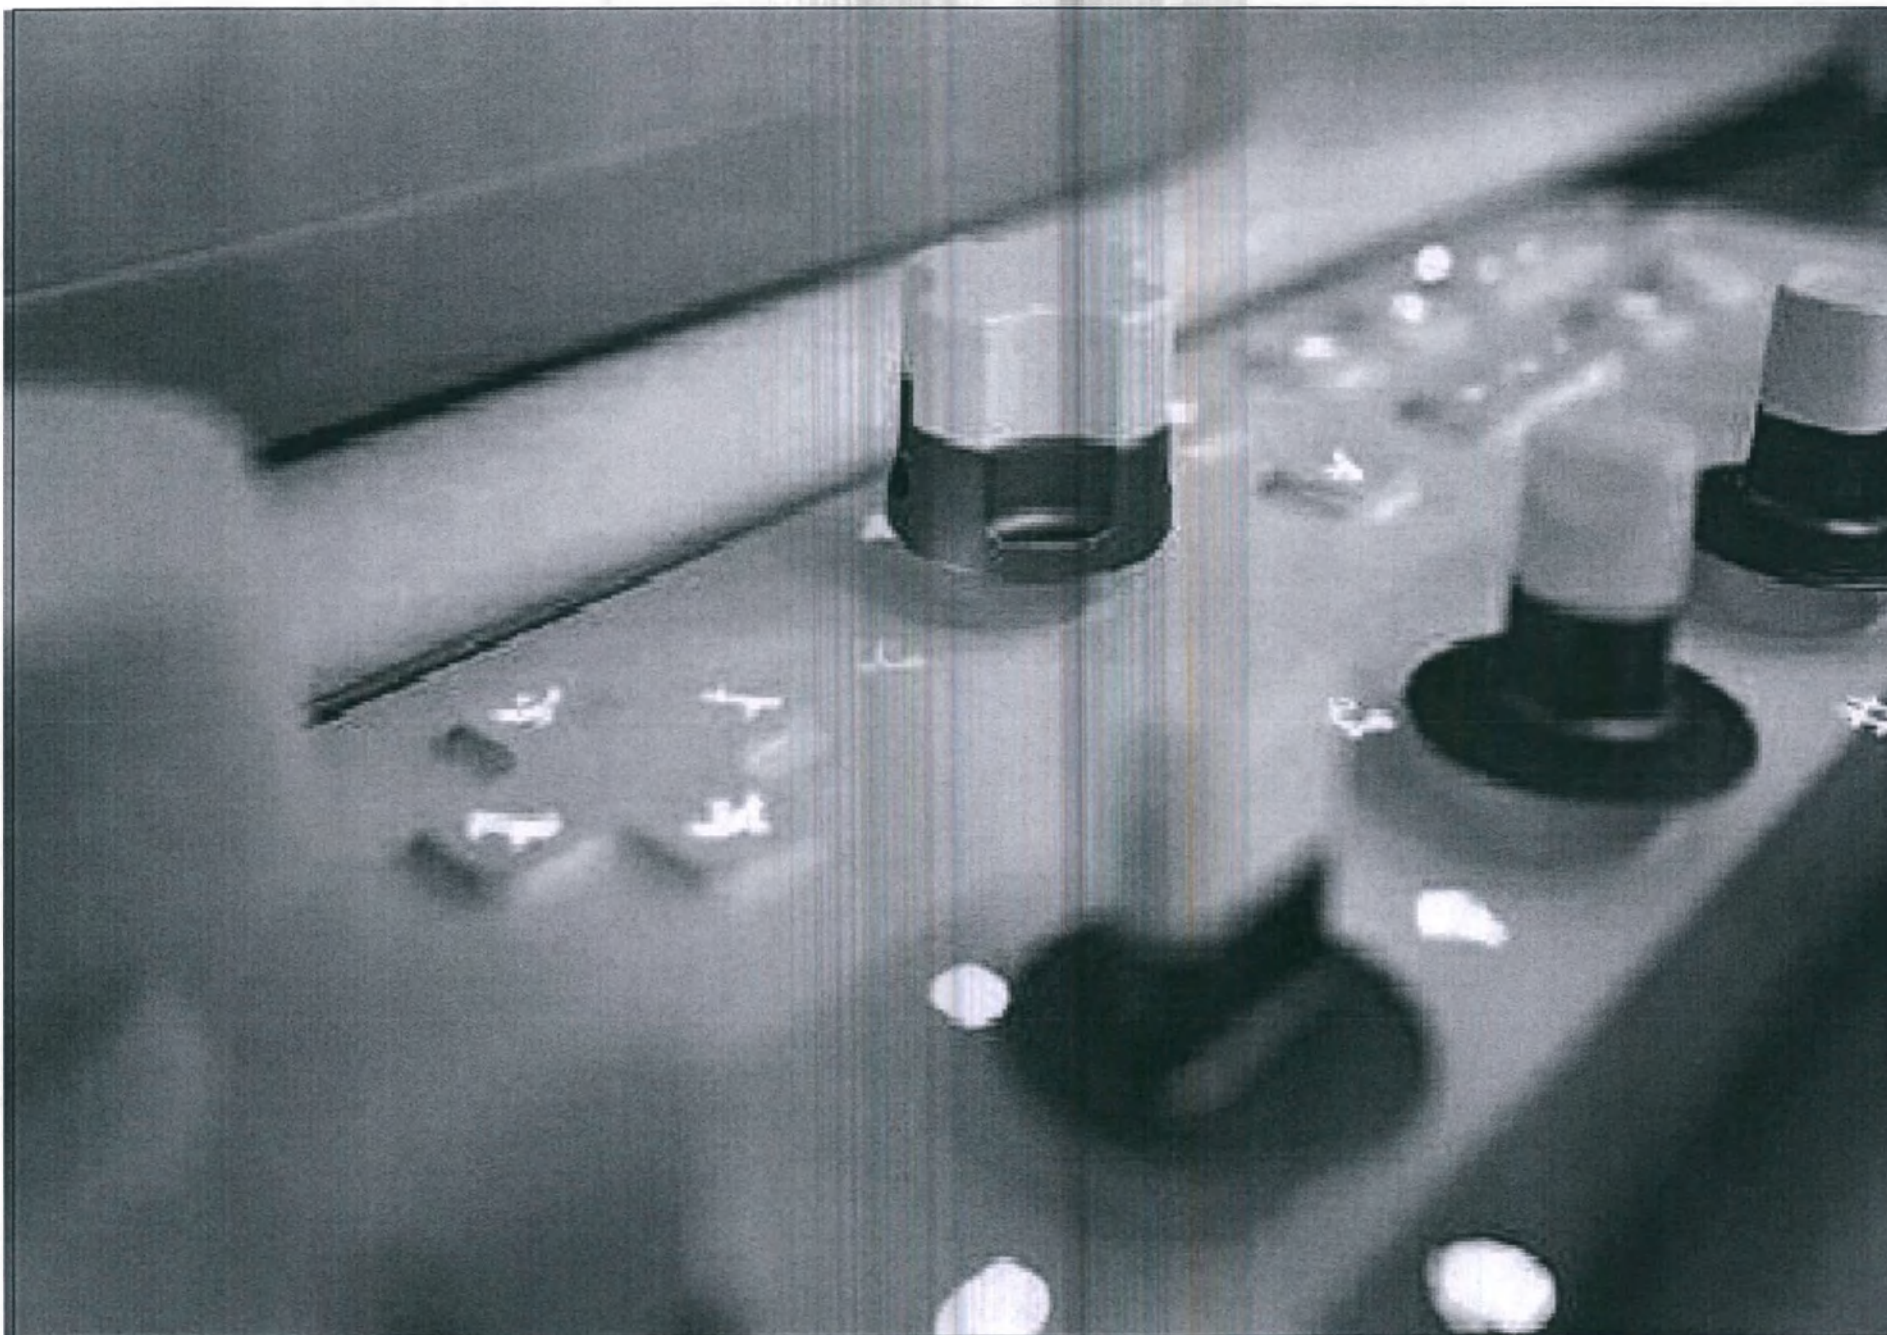


3.б. Модуль управления, , не более 4 шт. (для С-дуги с опцией FlexArm).

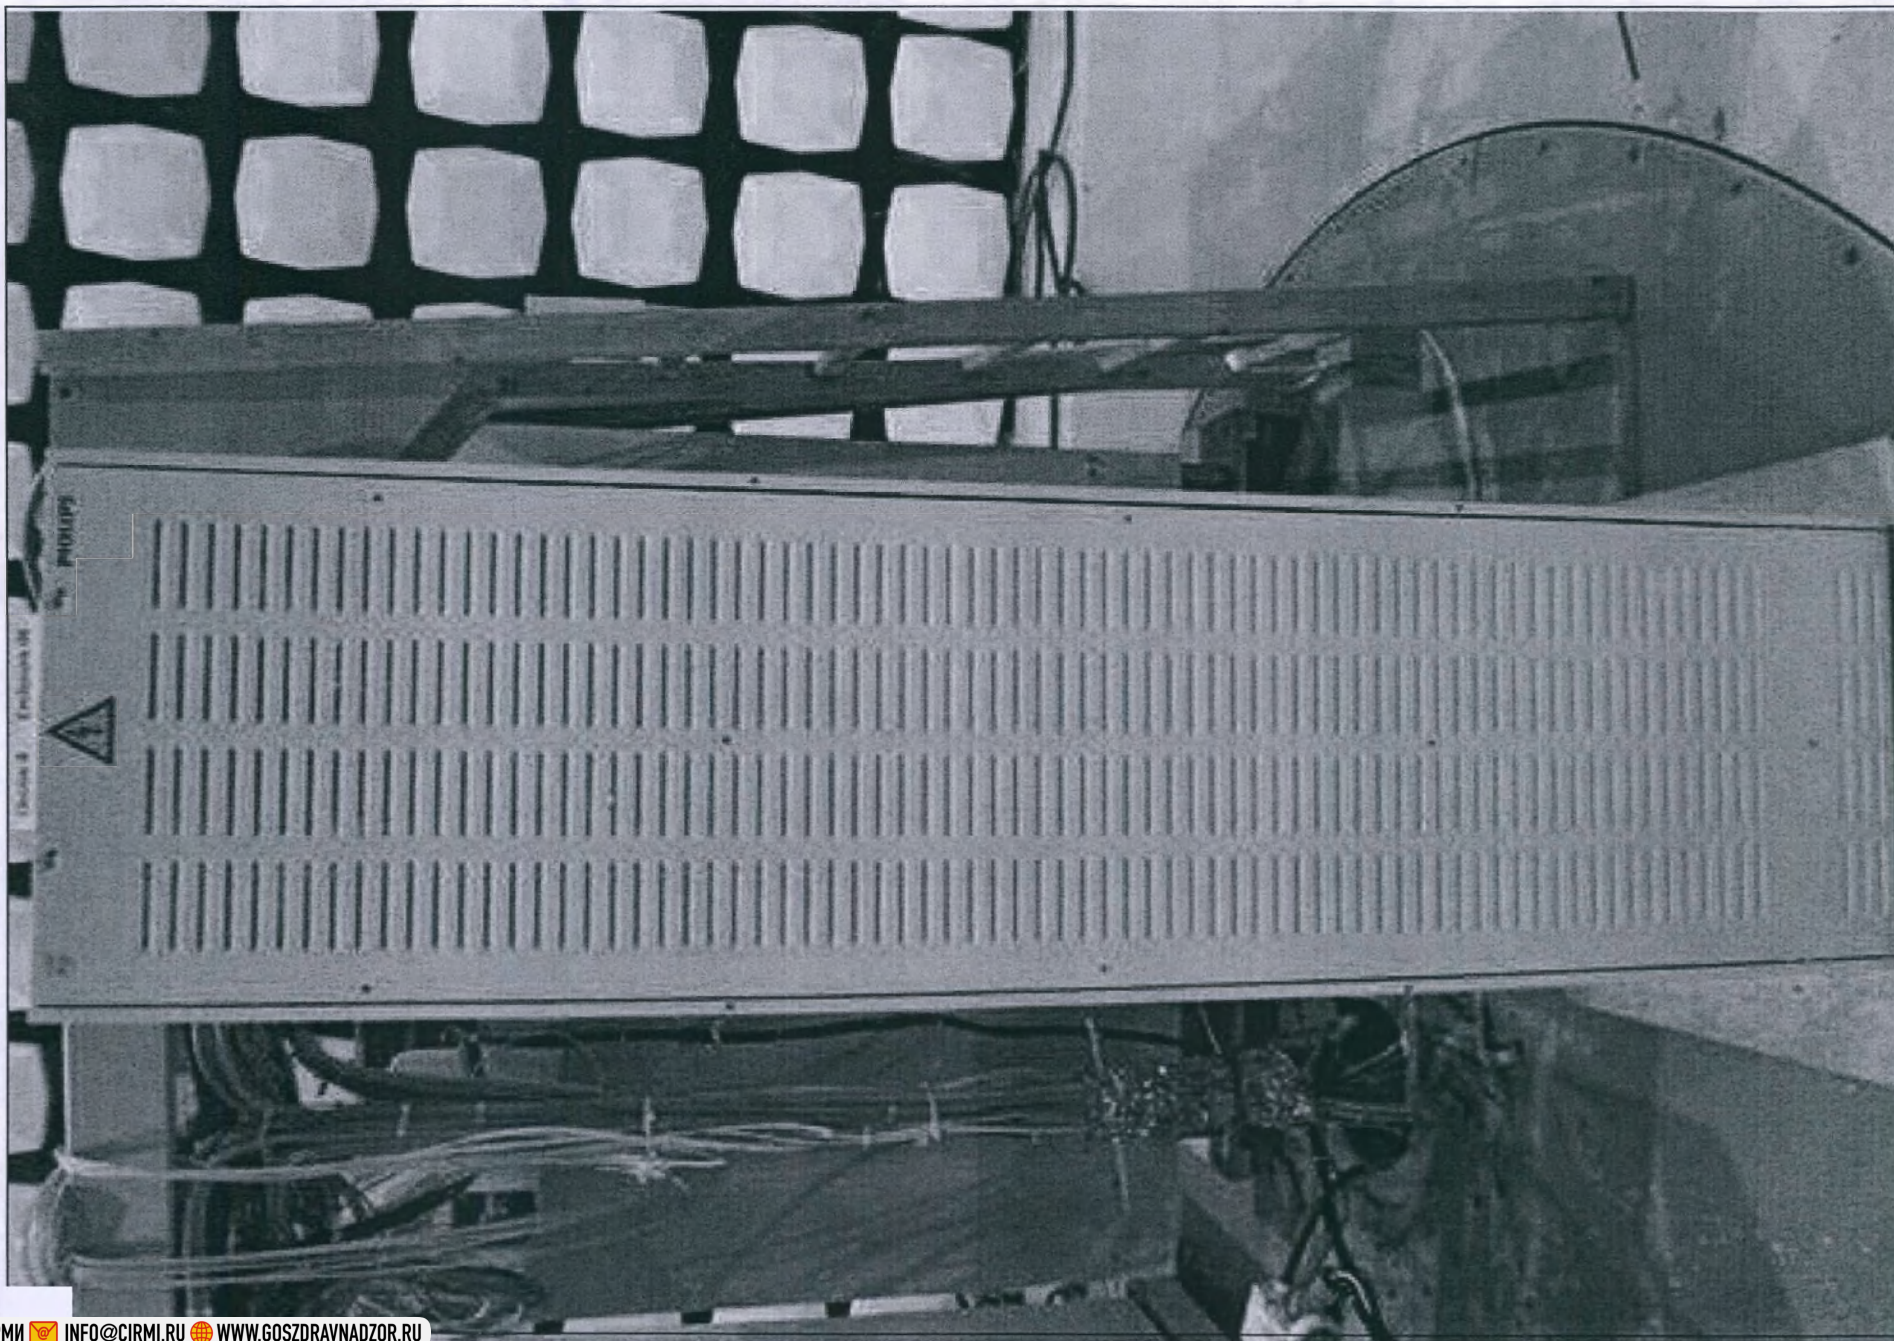


4.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

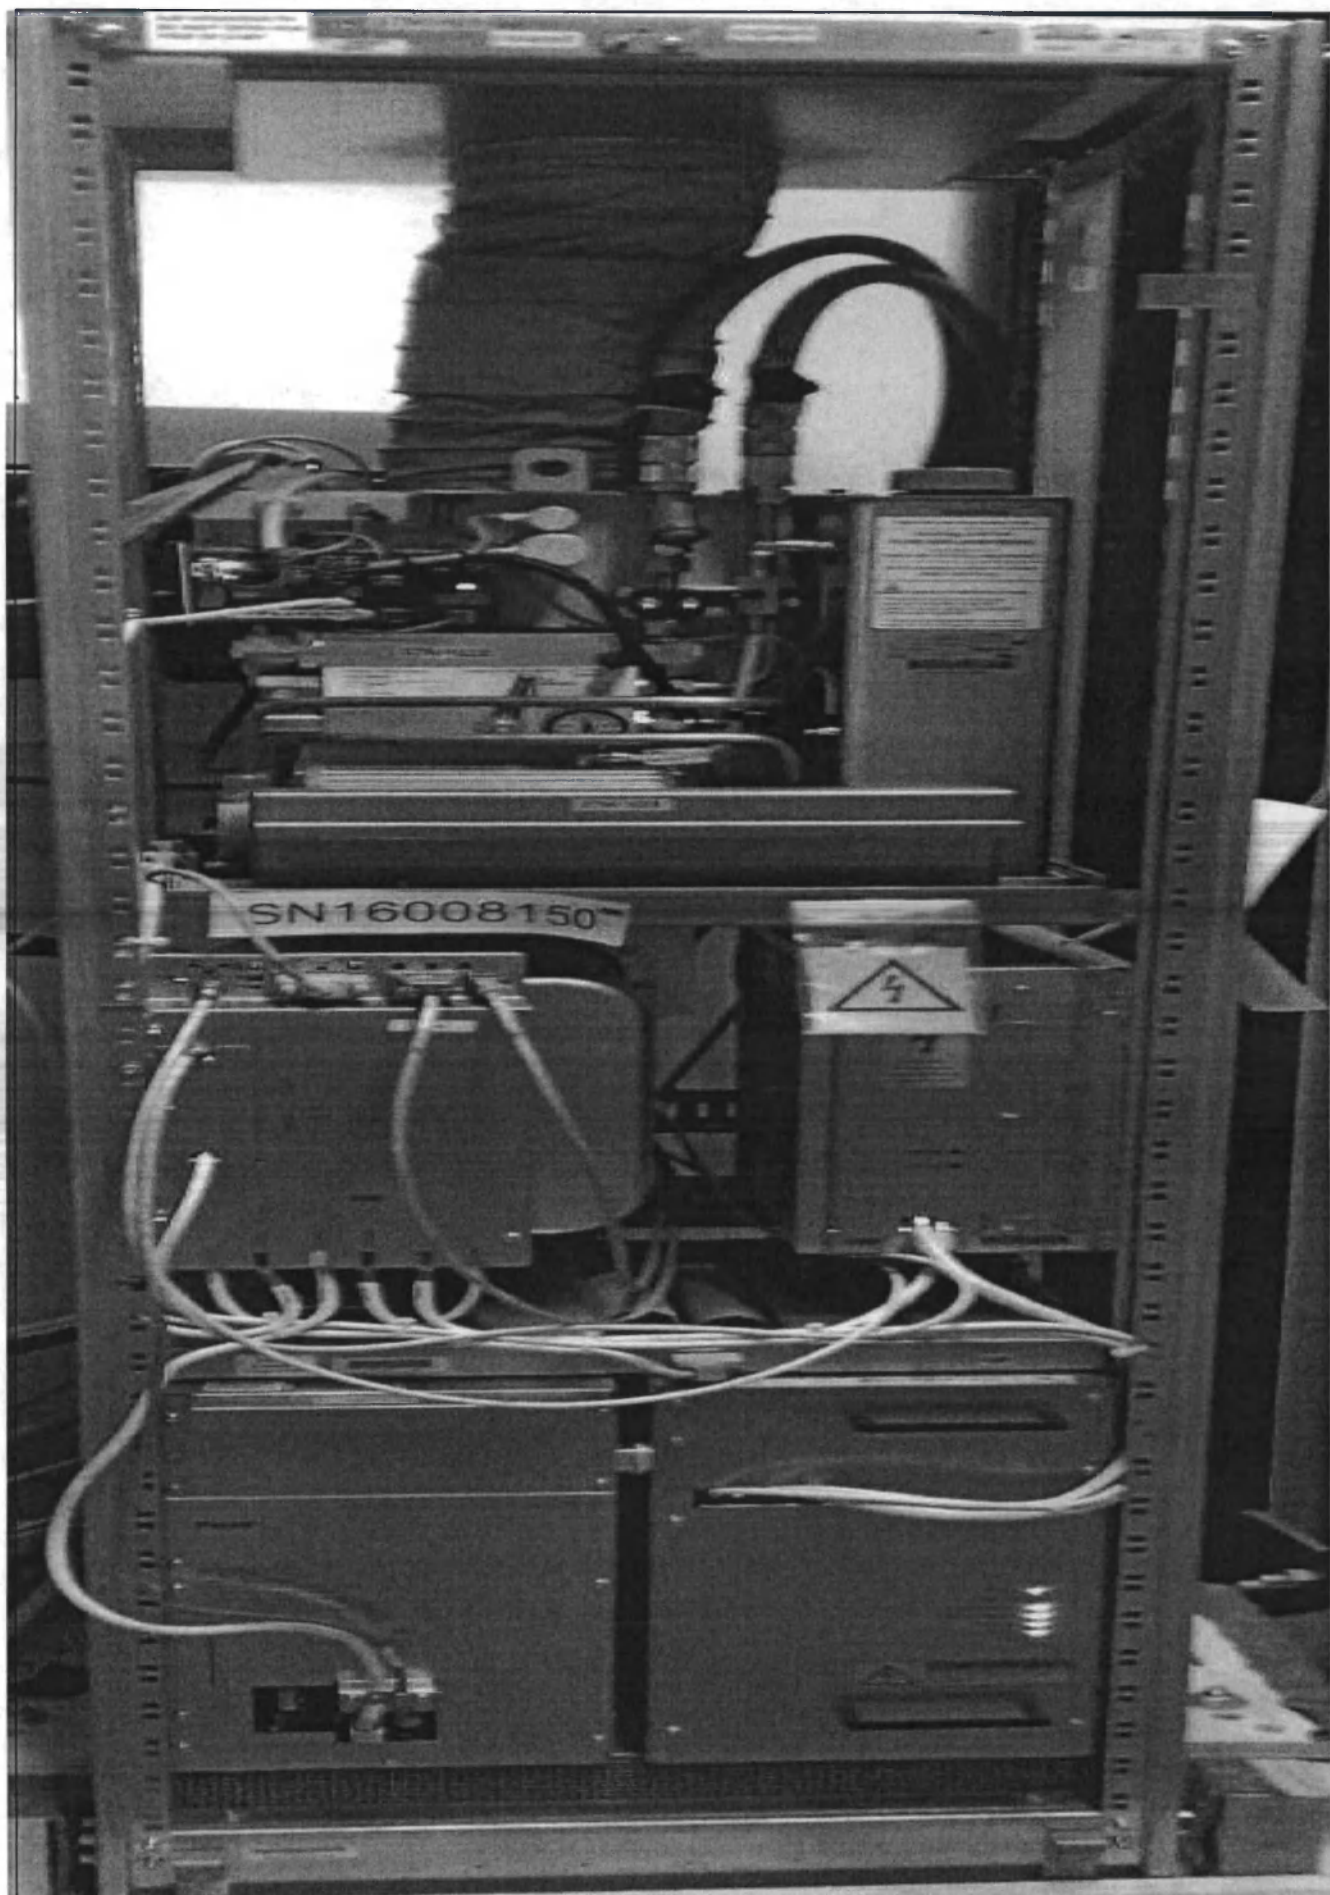


4.б. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

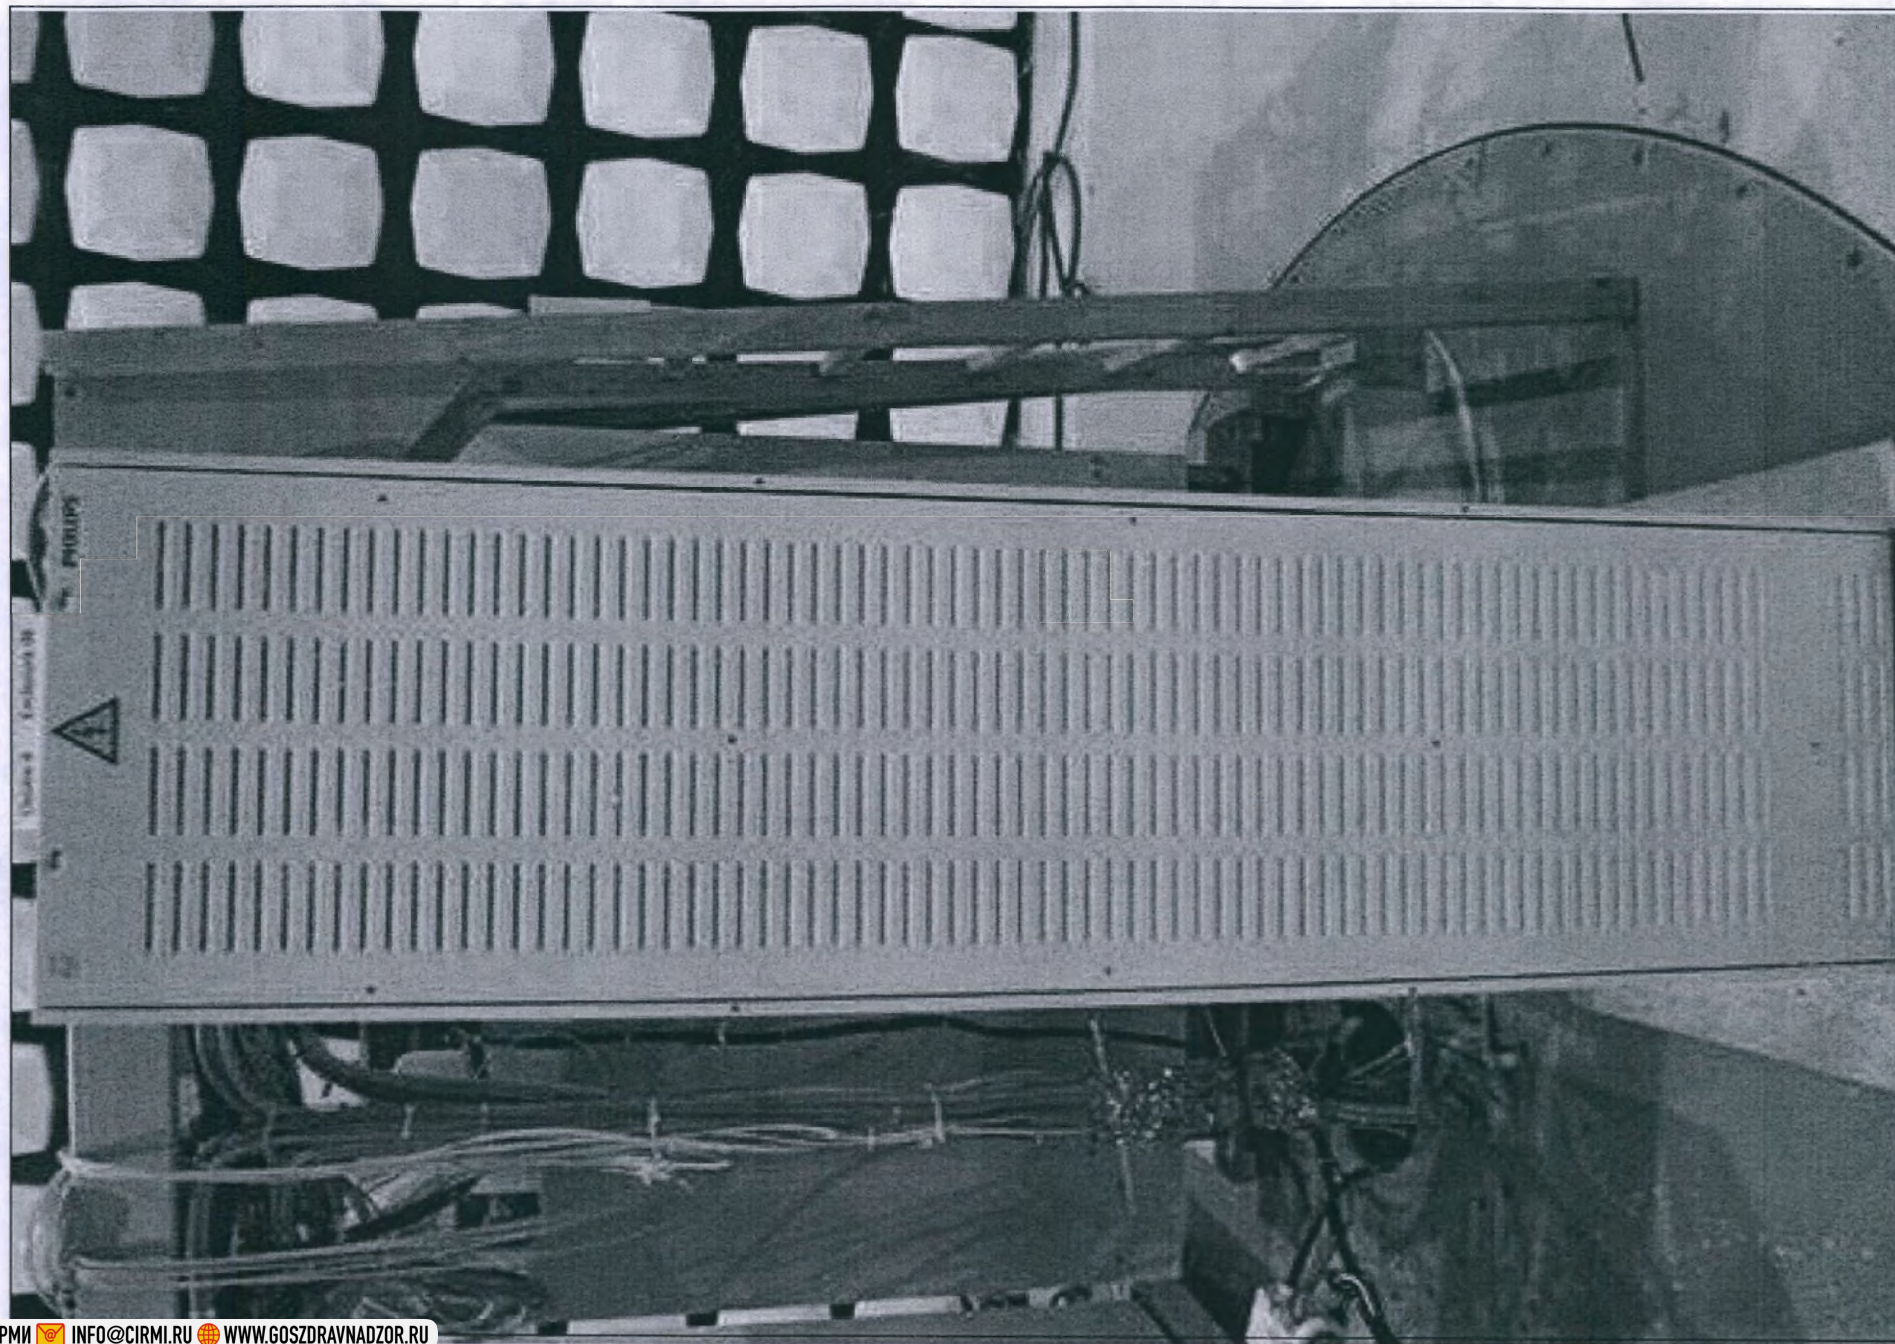


5.а. Шкаф управления.

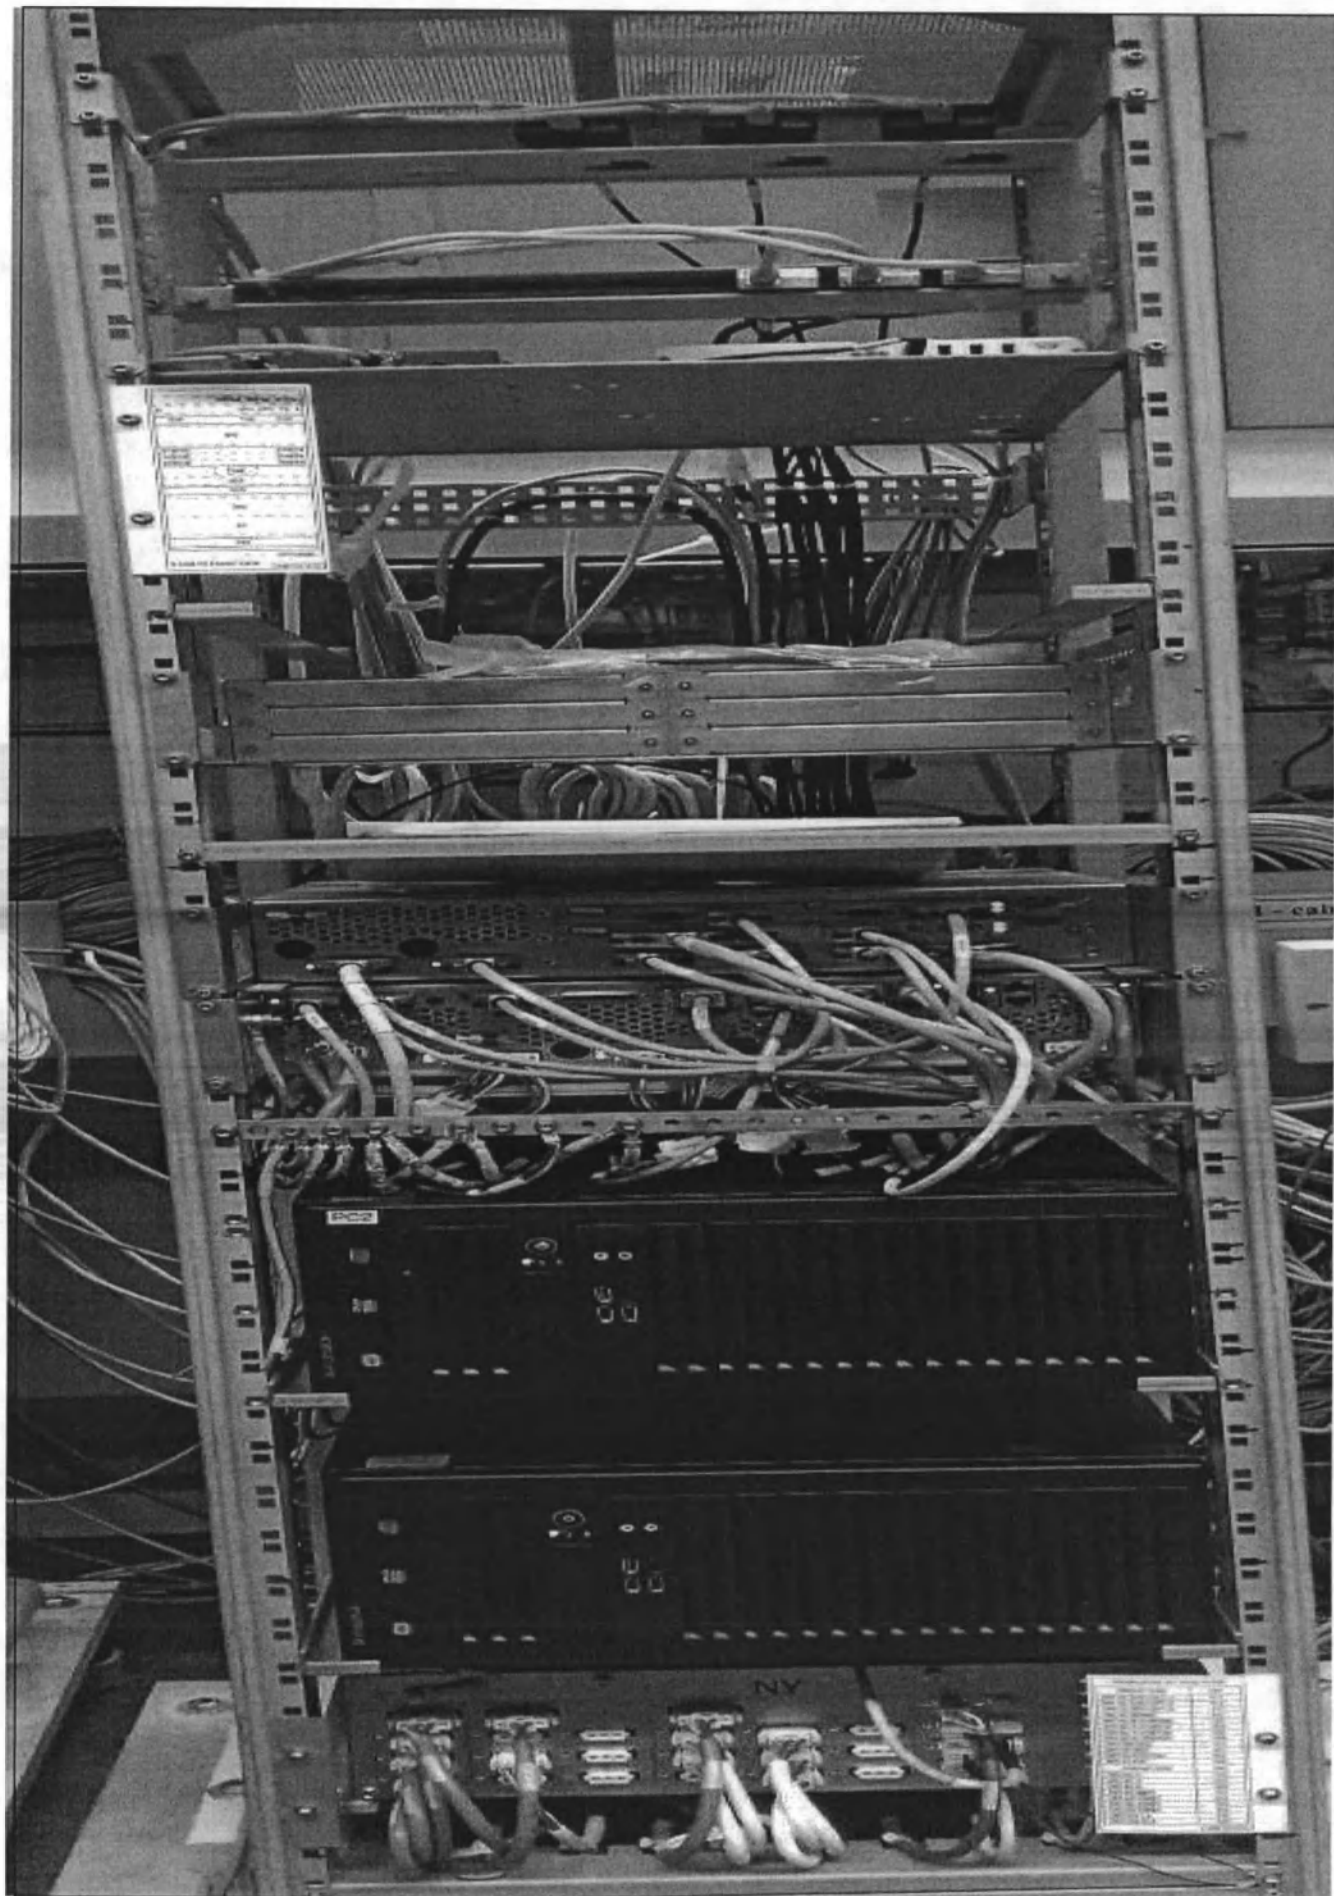

5.6. Шкаф управления.

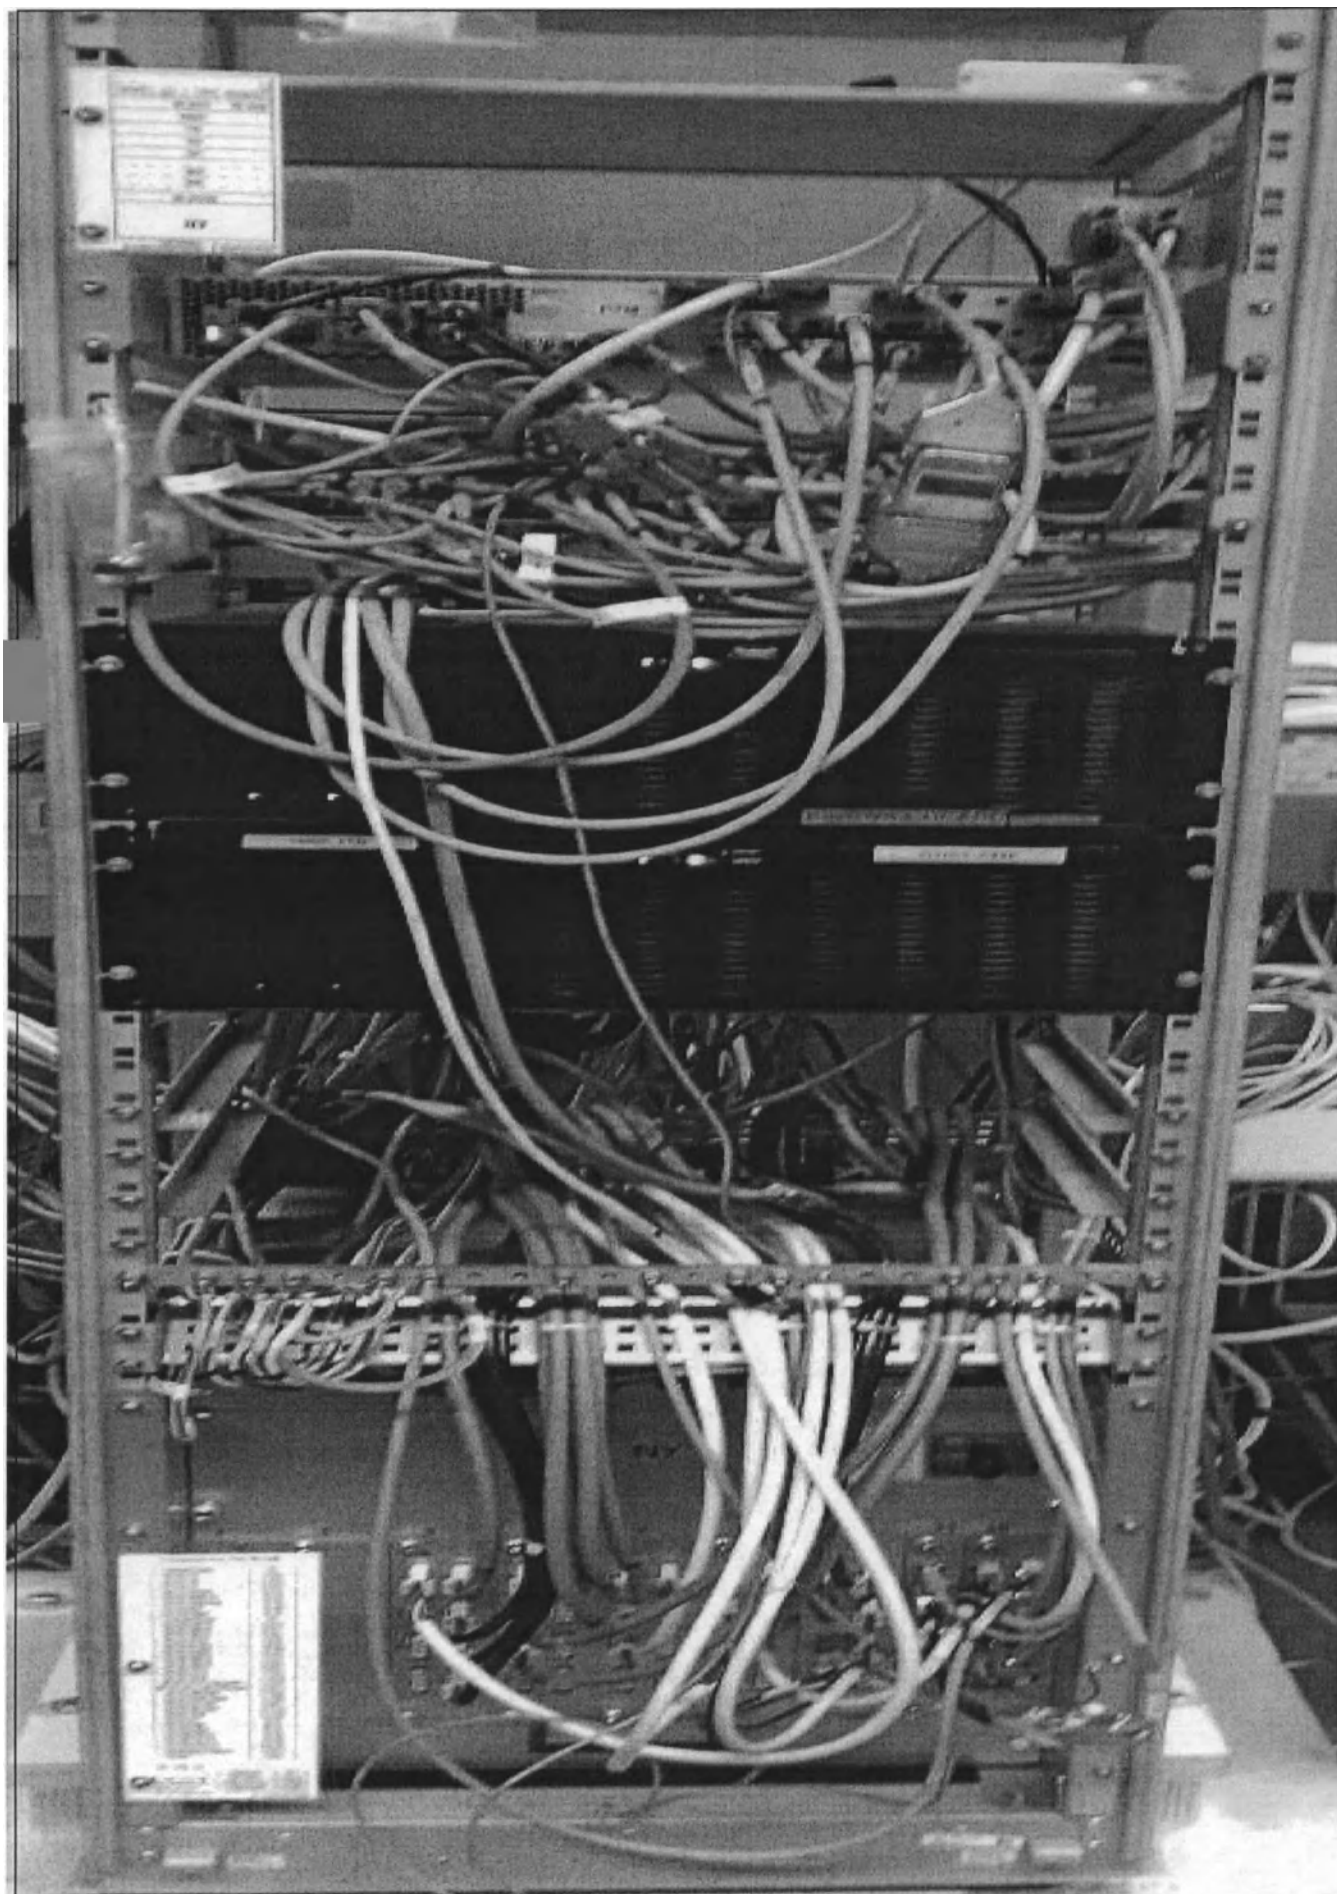


б.а. Распределительный щит.

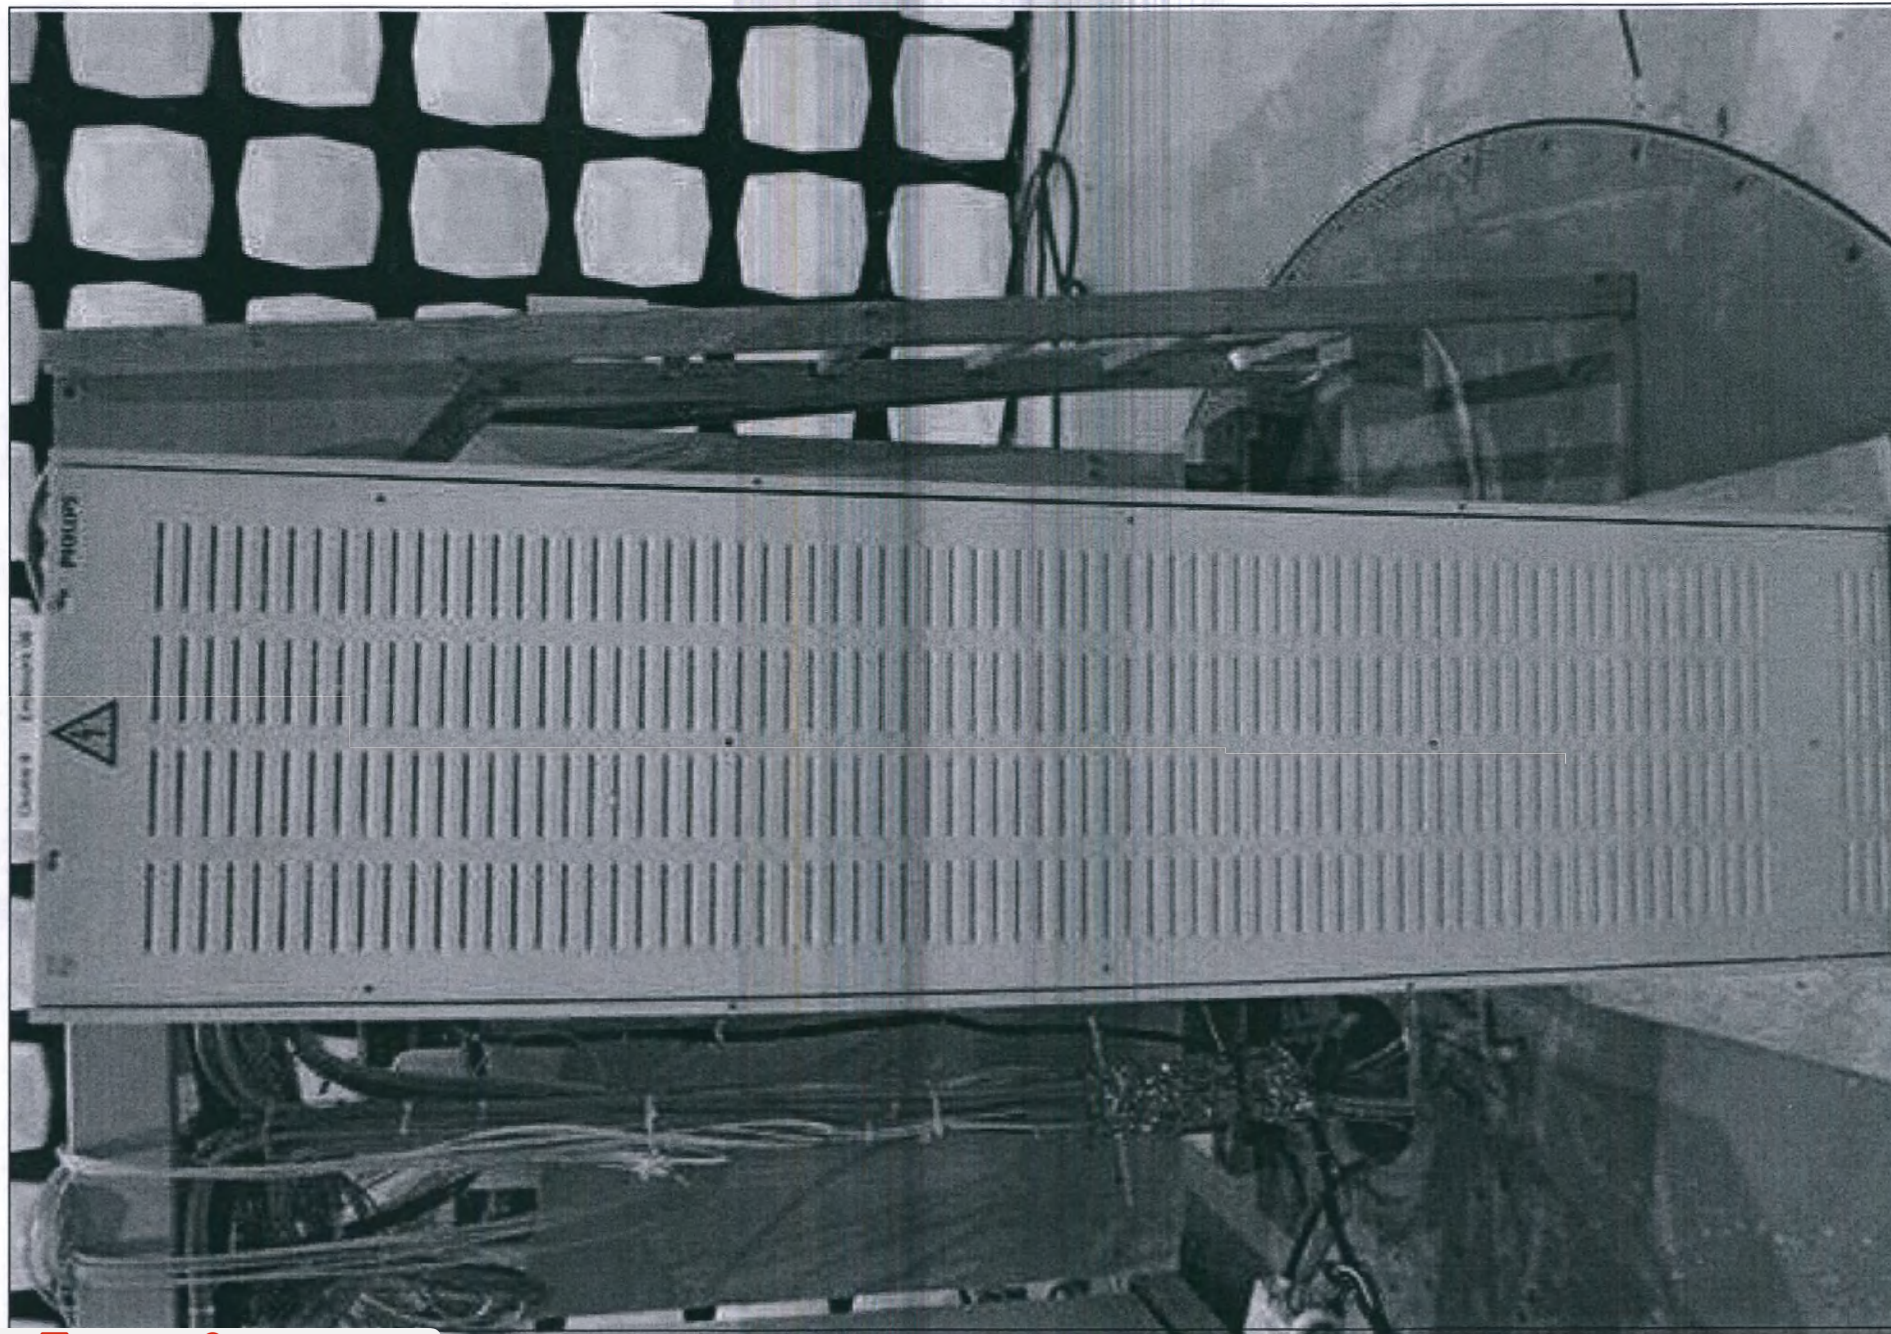


6.6. Распределительный щит.




7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

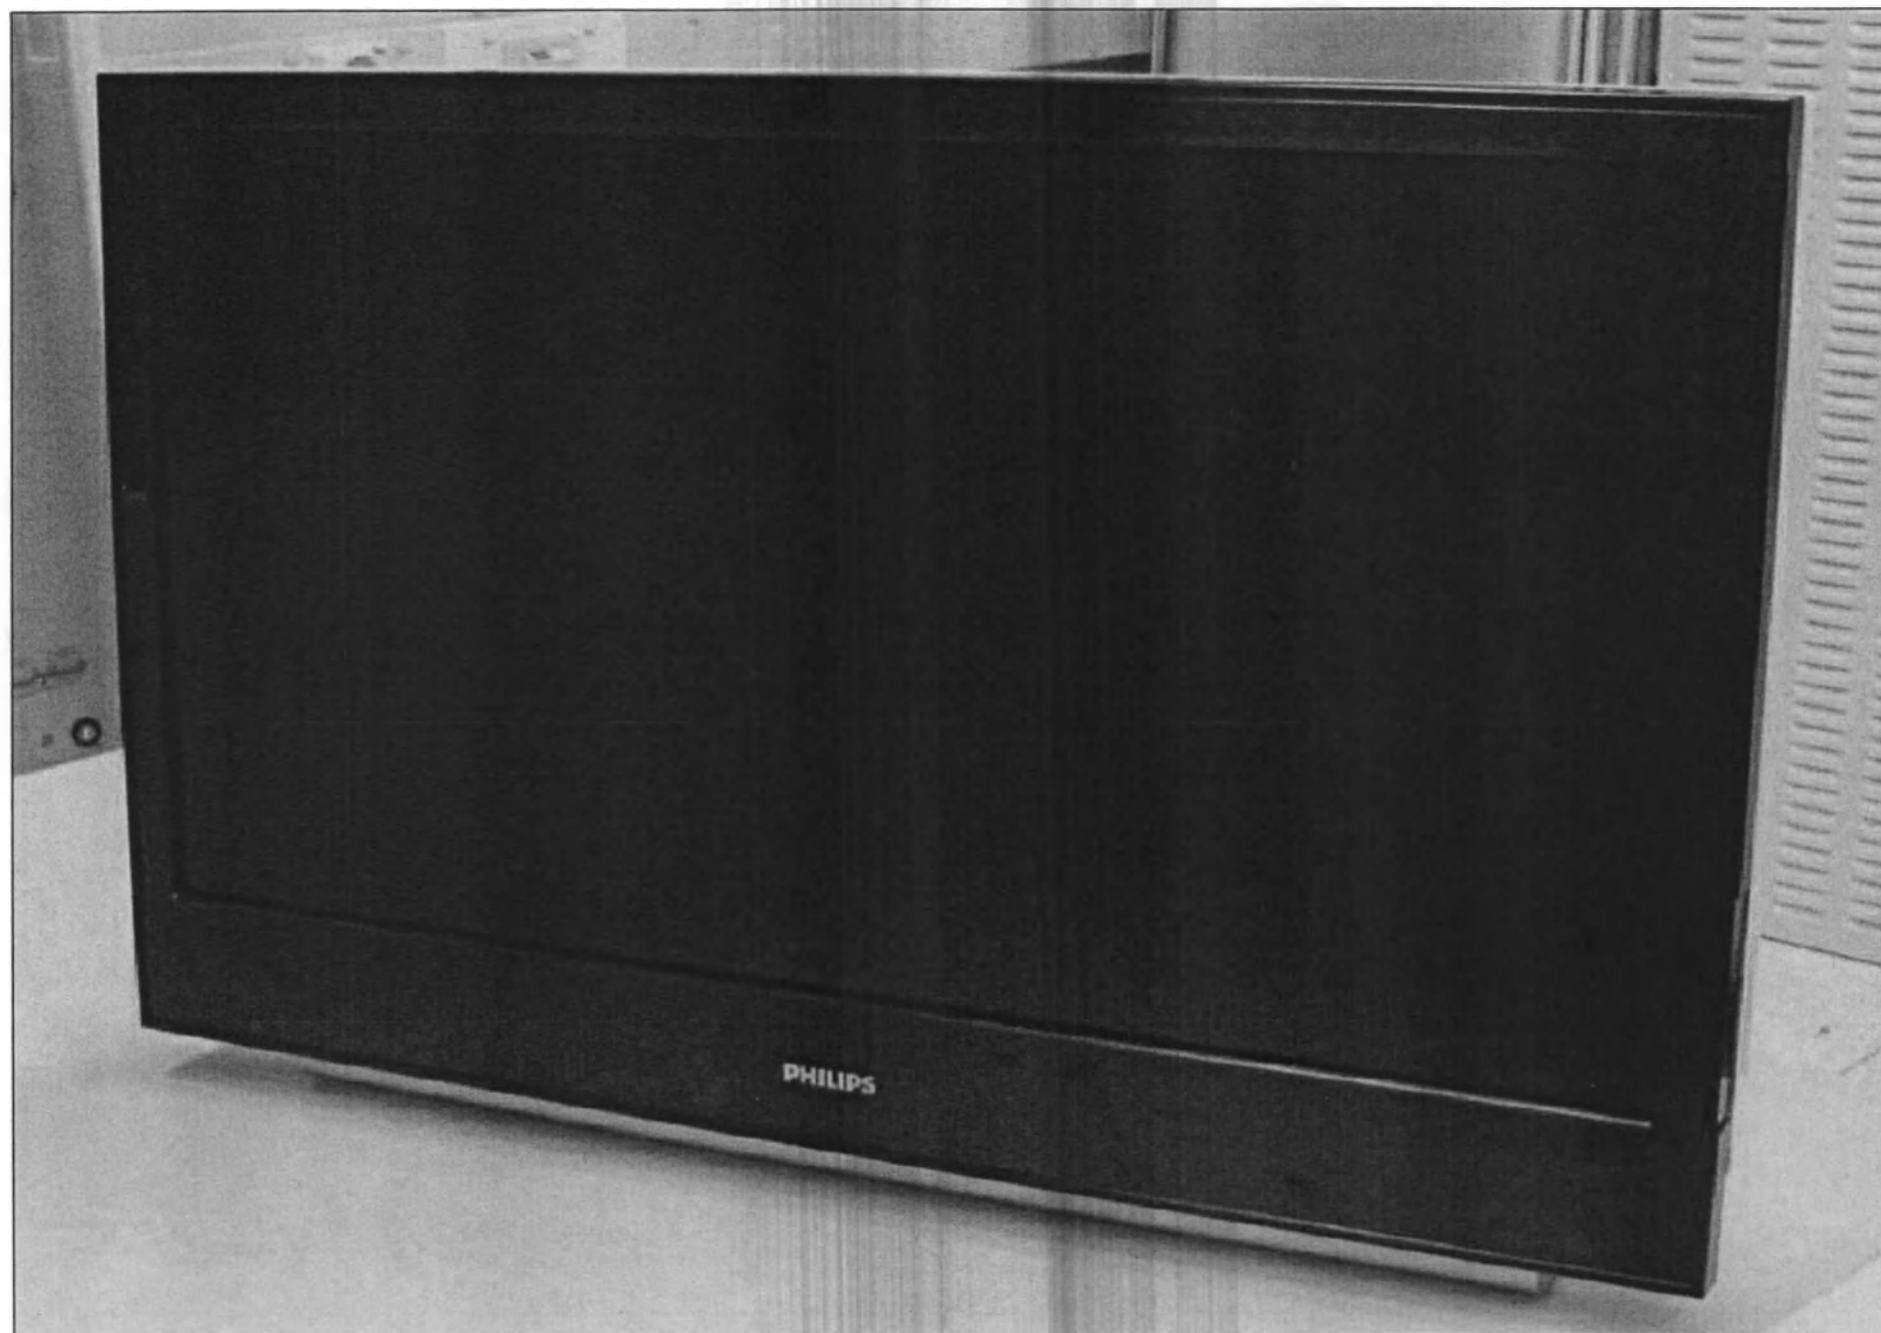

8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

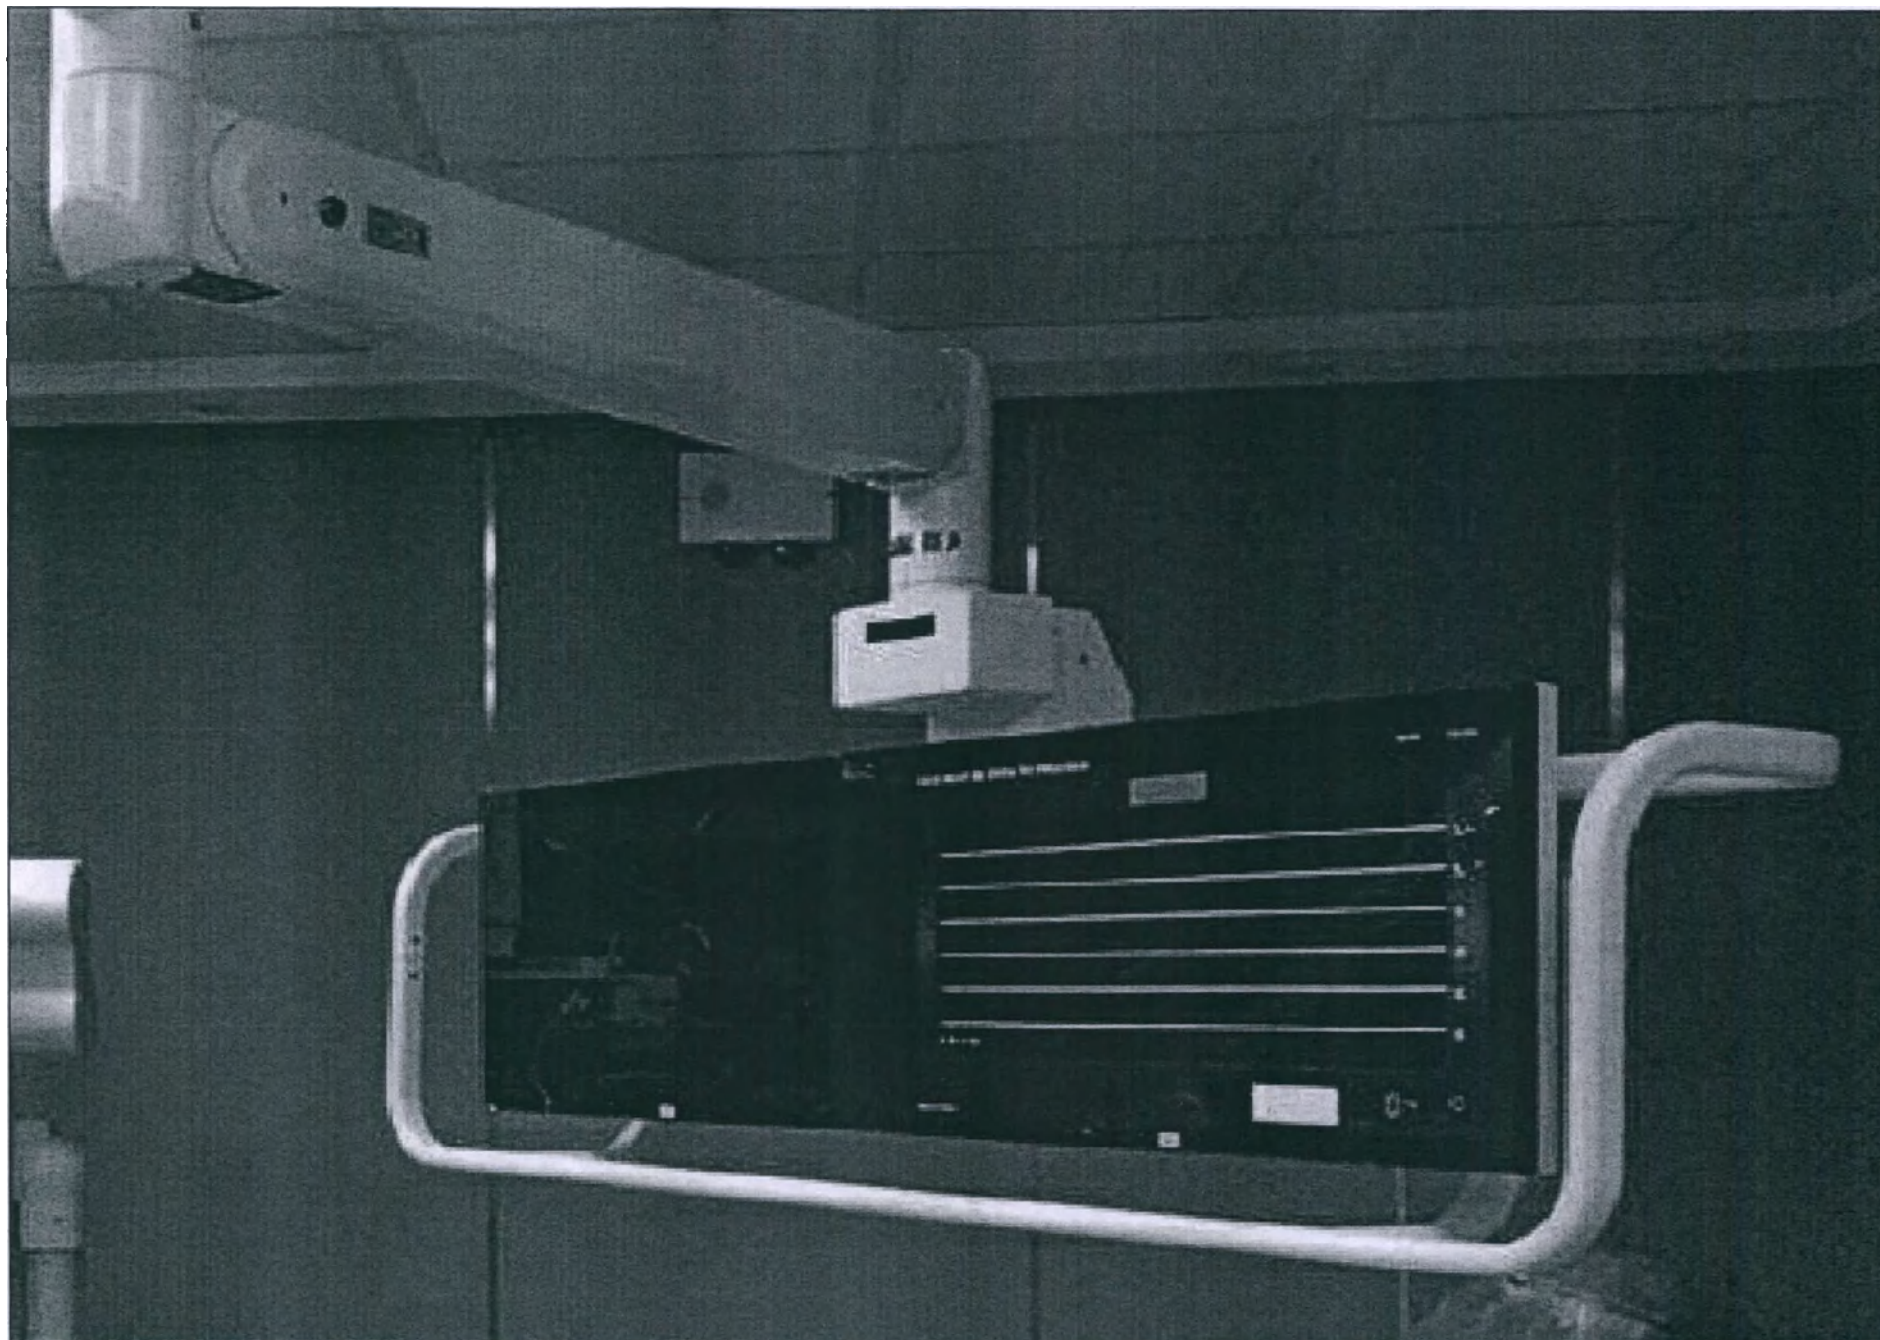


9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

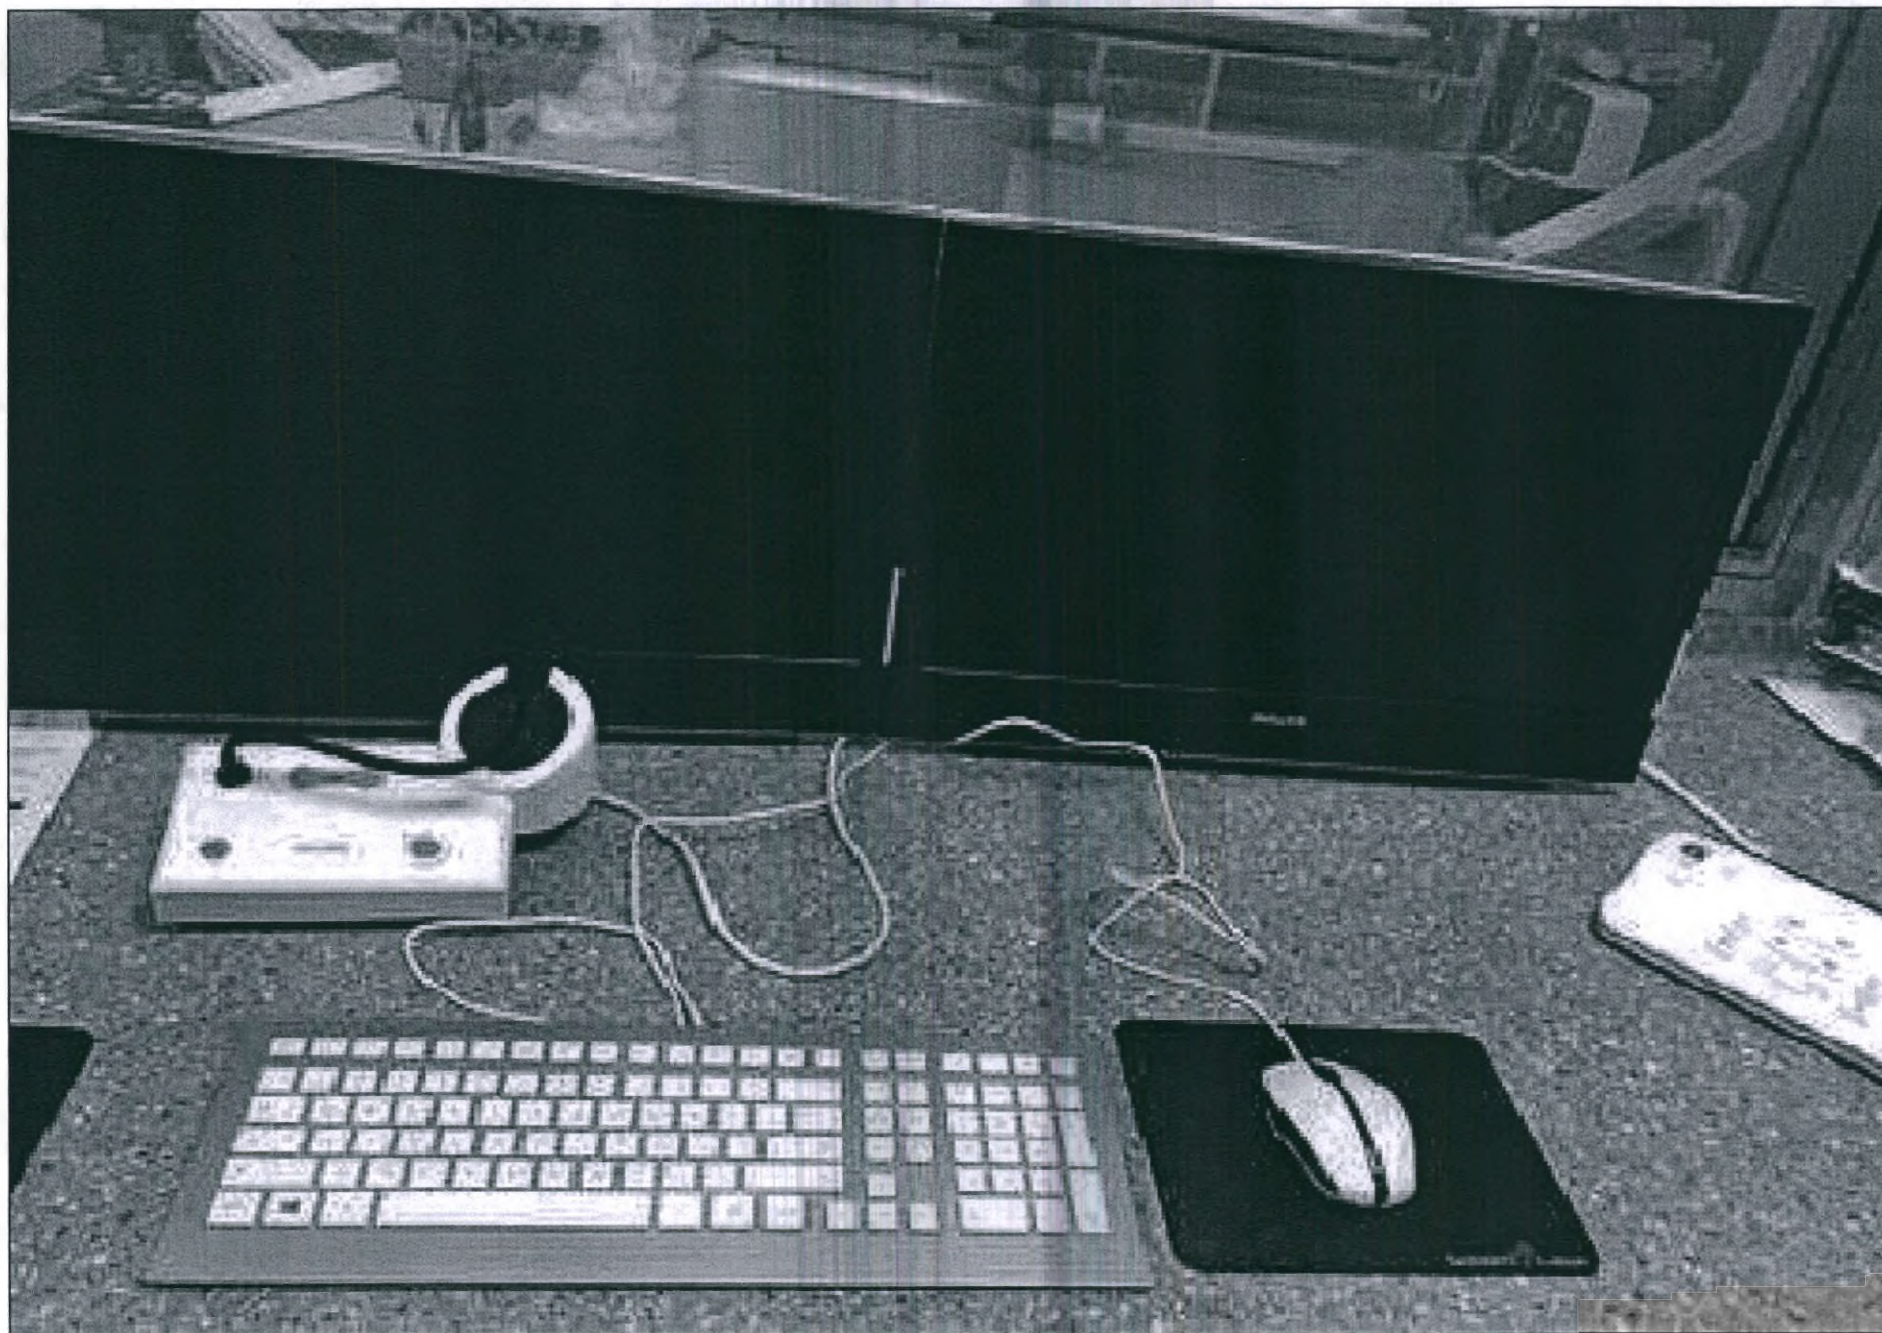


10.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.



10.6. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

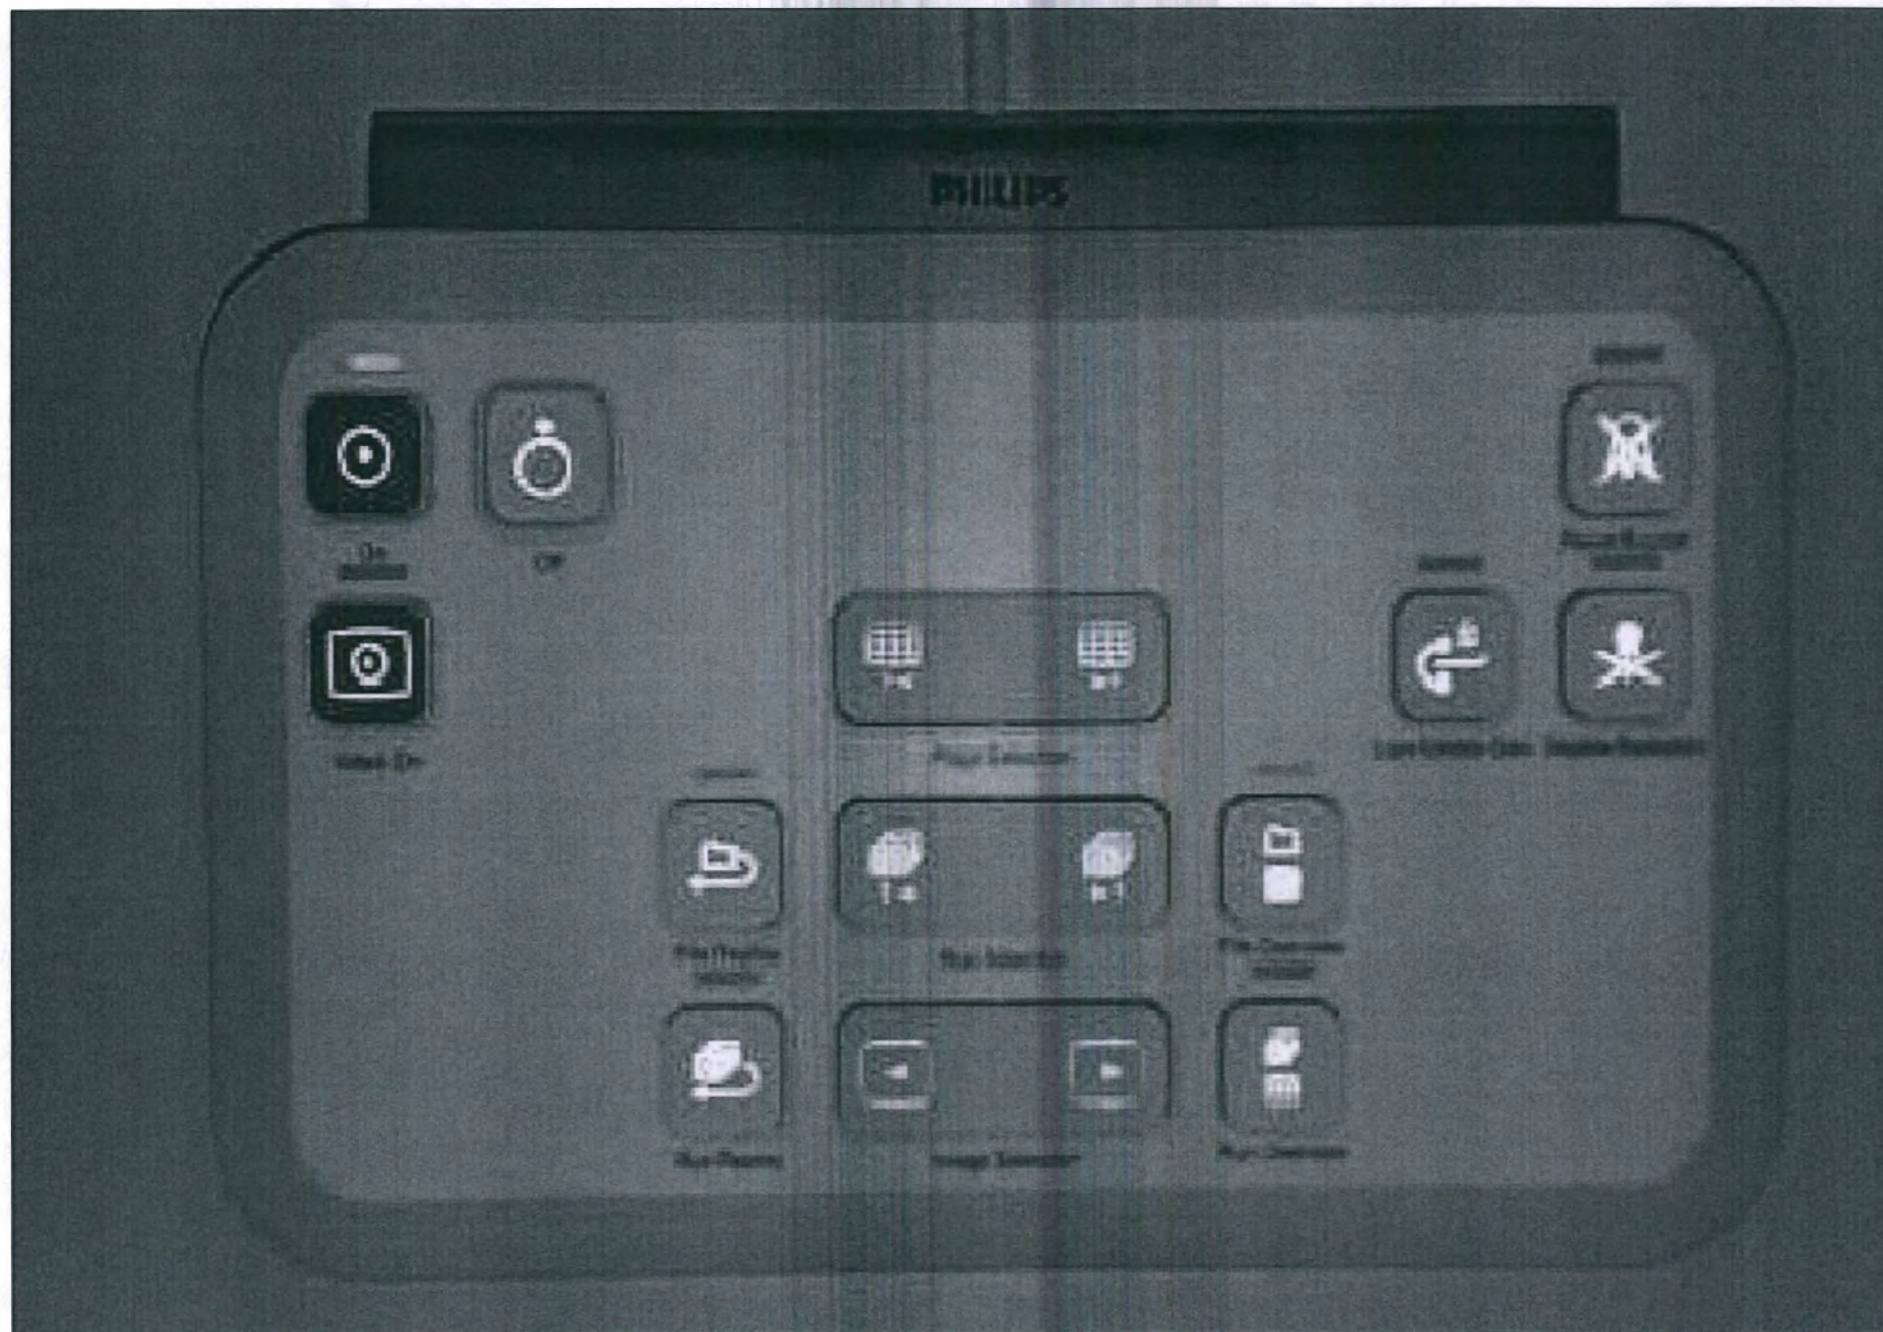


10.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

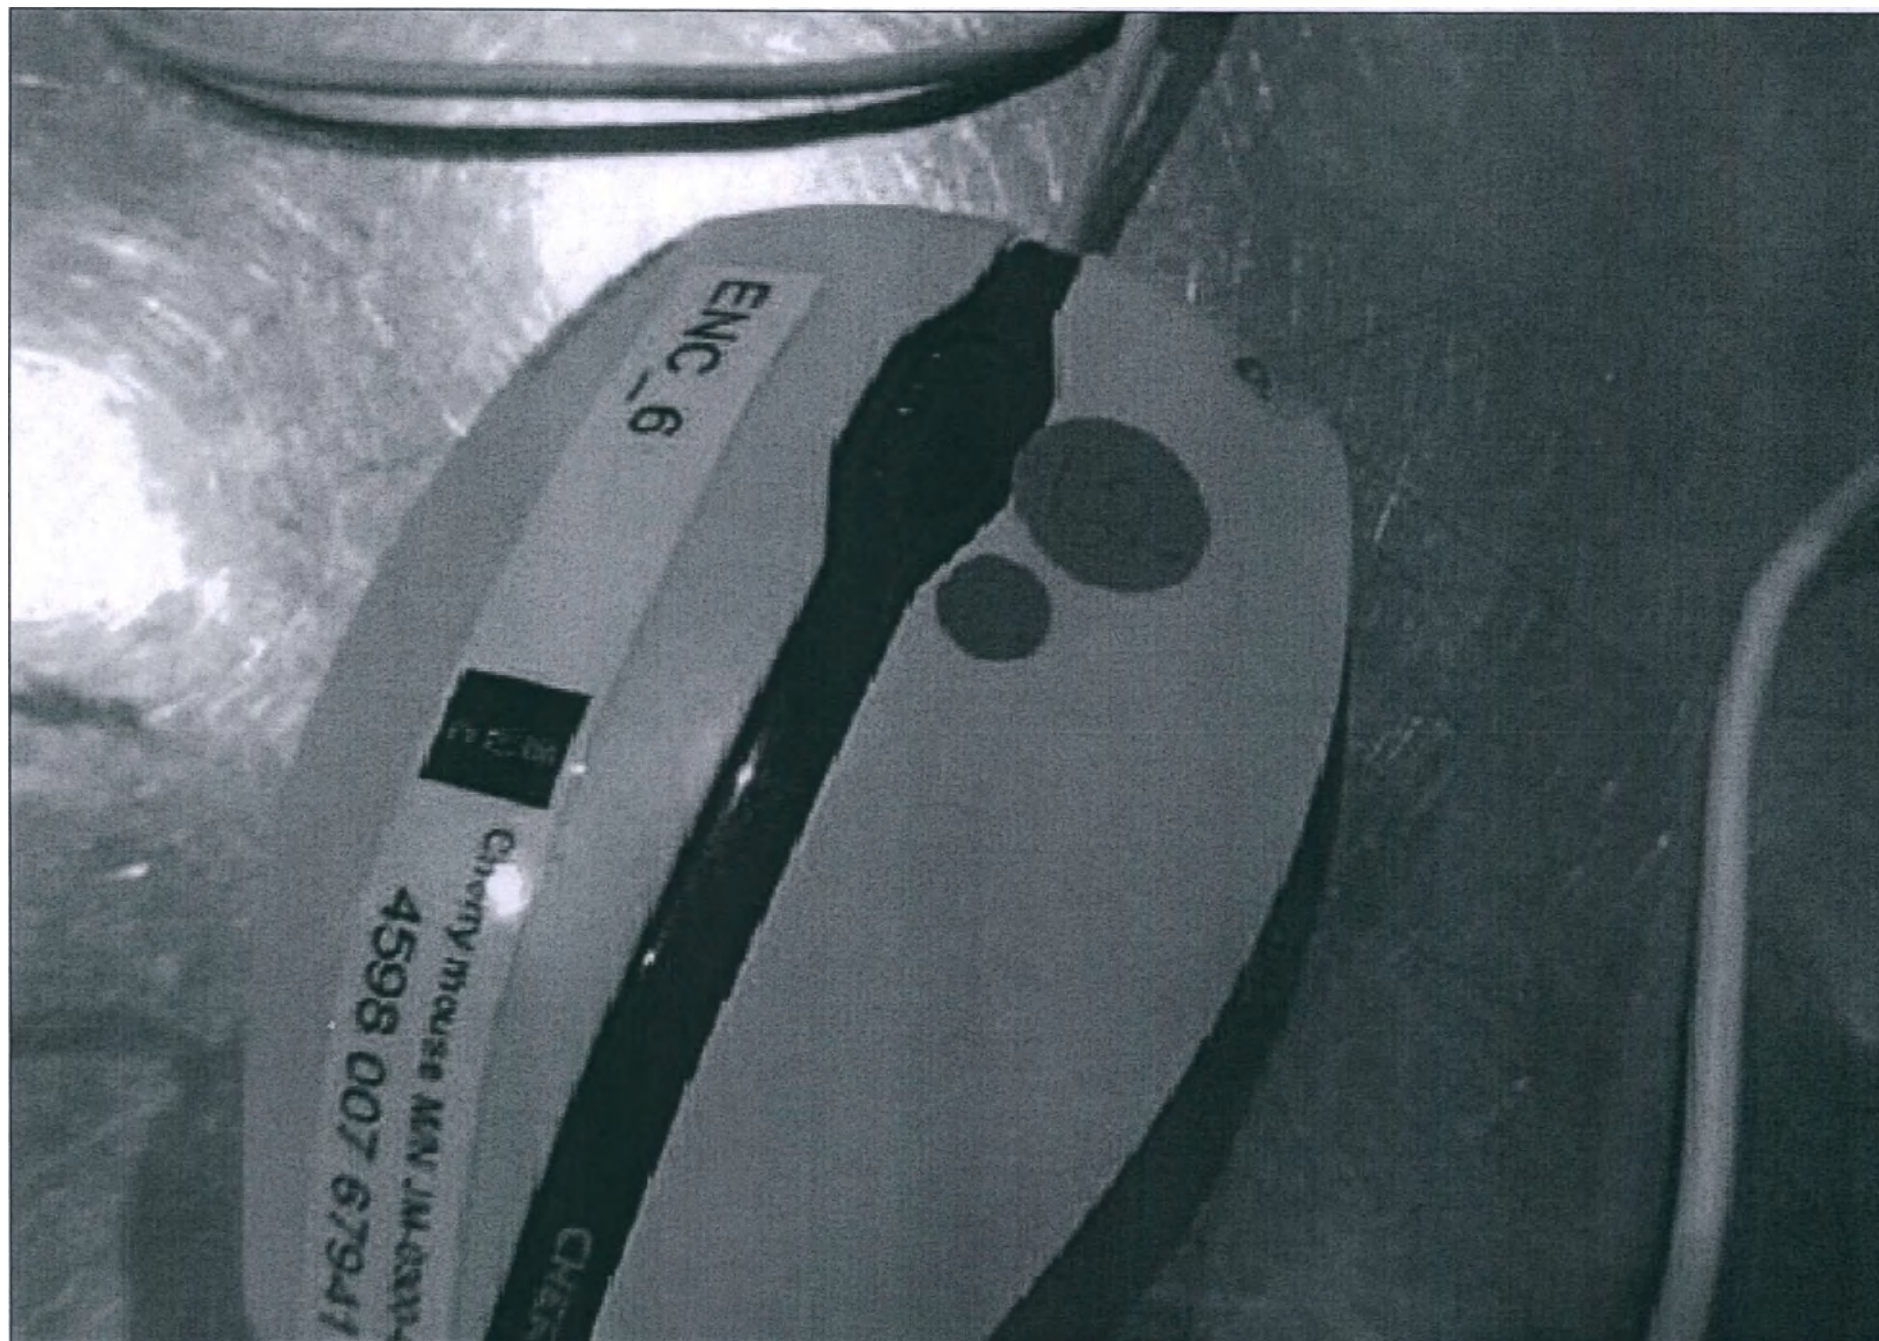

10.г. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.




10.д. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

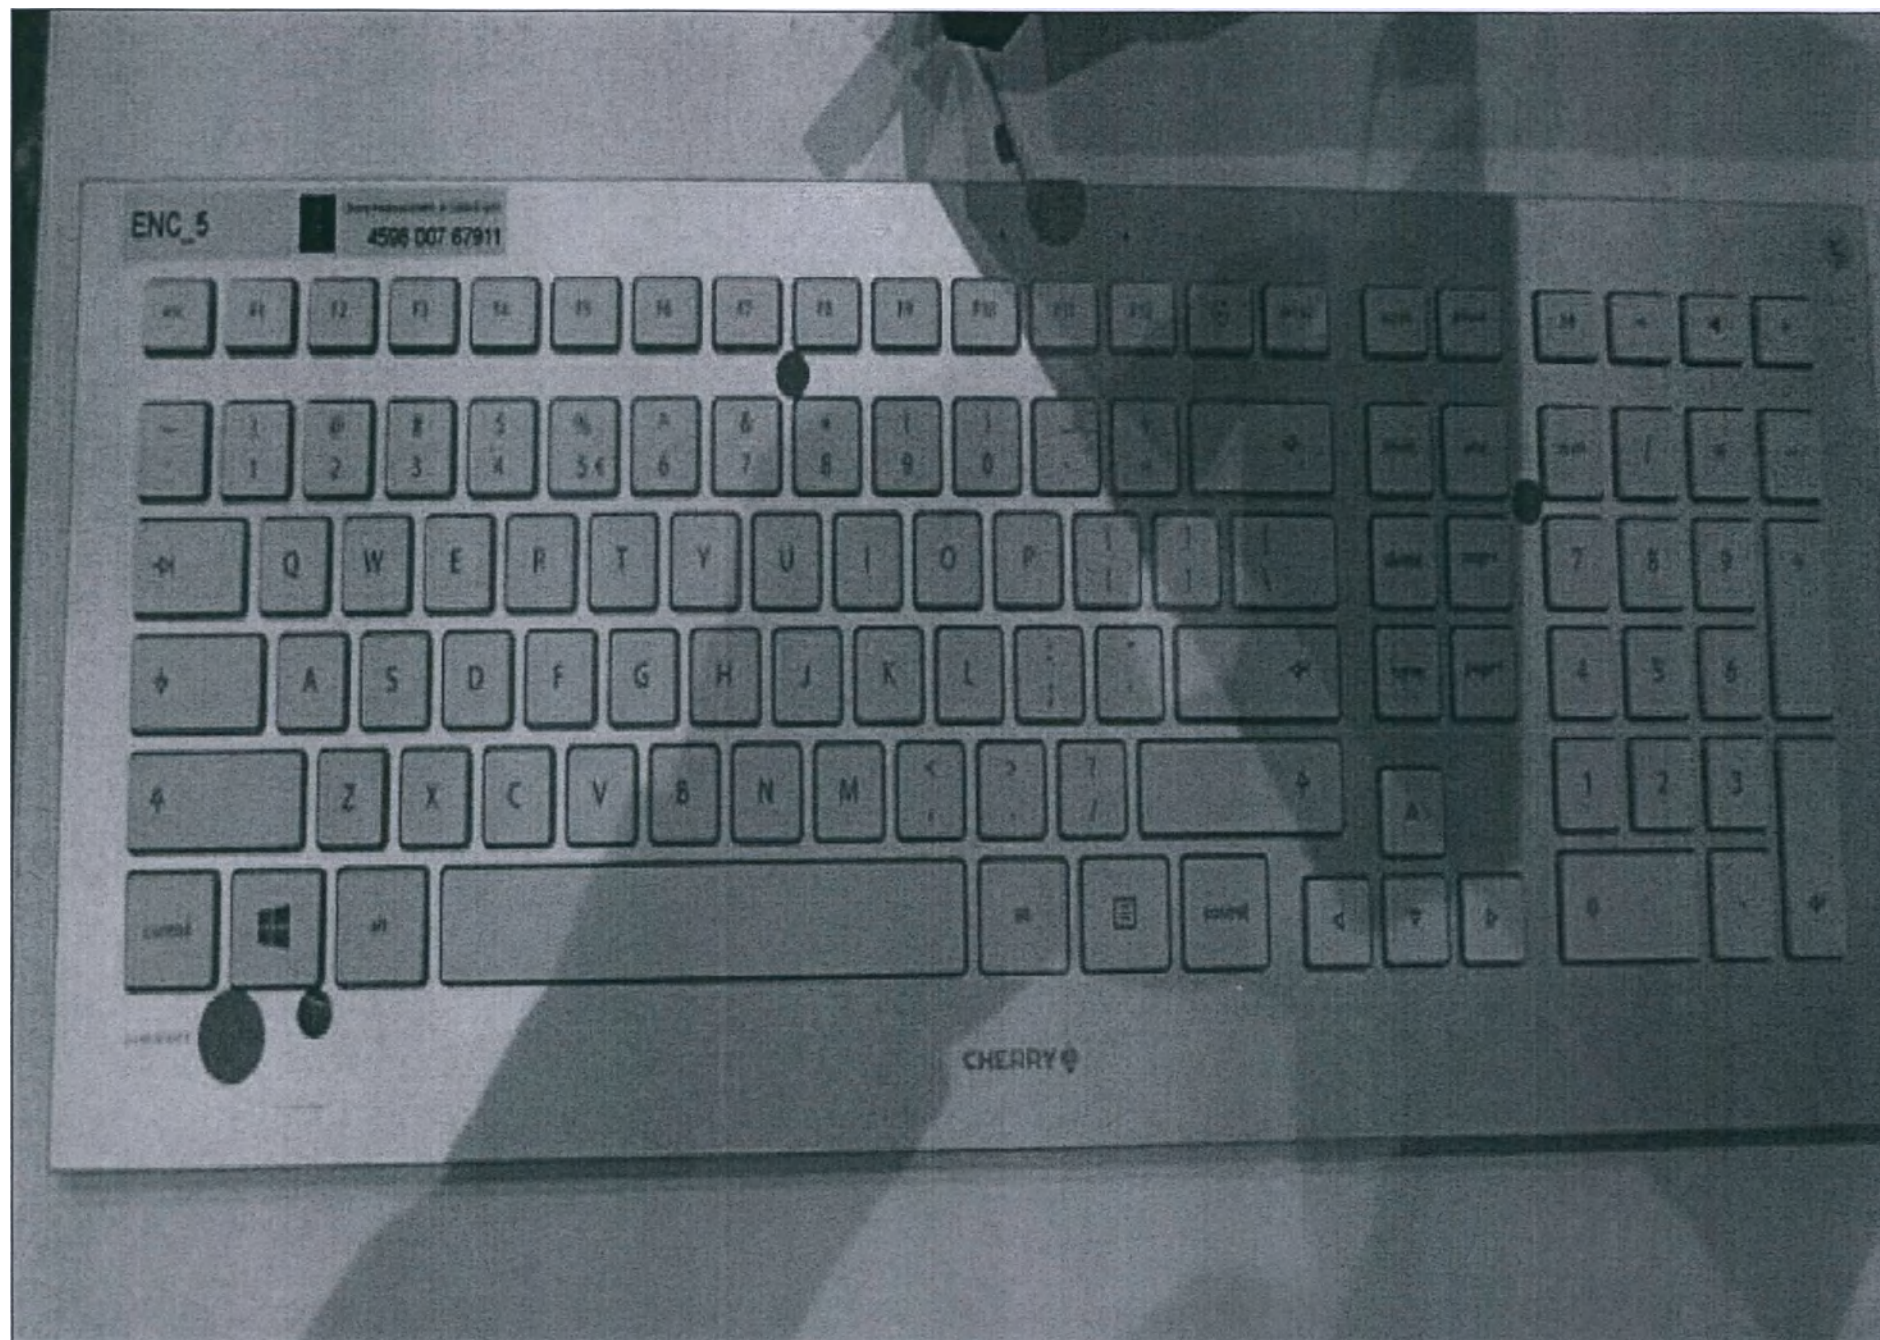


10.e. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.




10.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

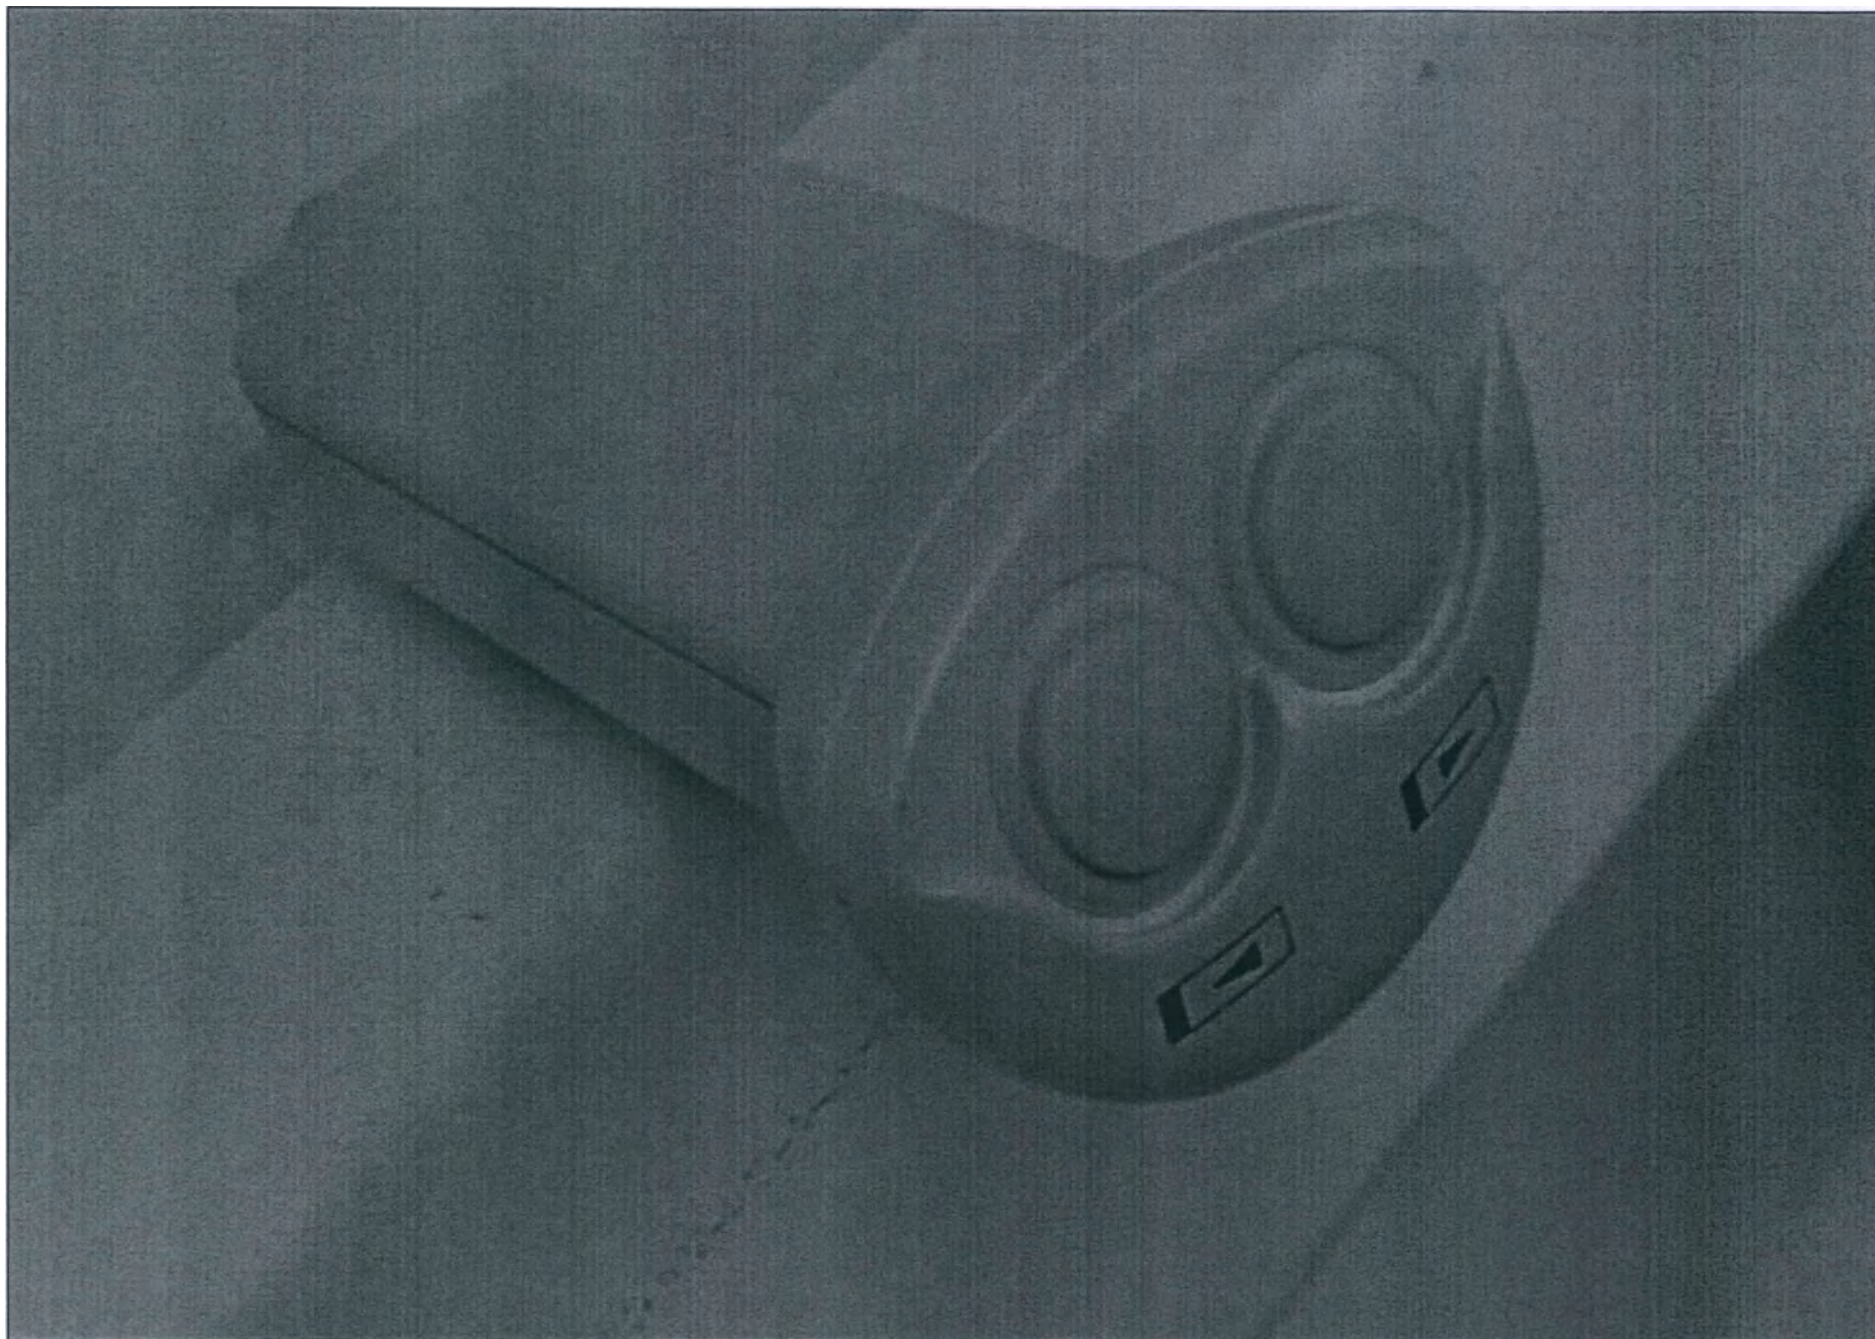

11. Ручной переключатель сдвига.

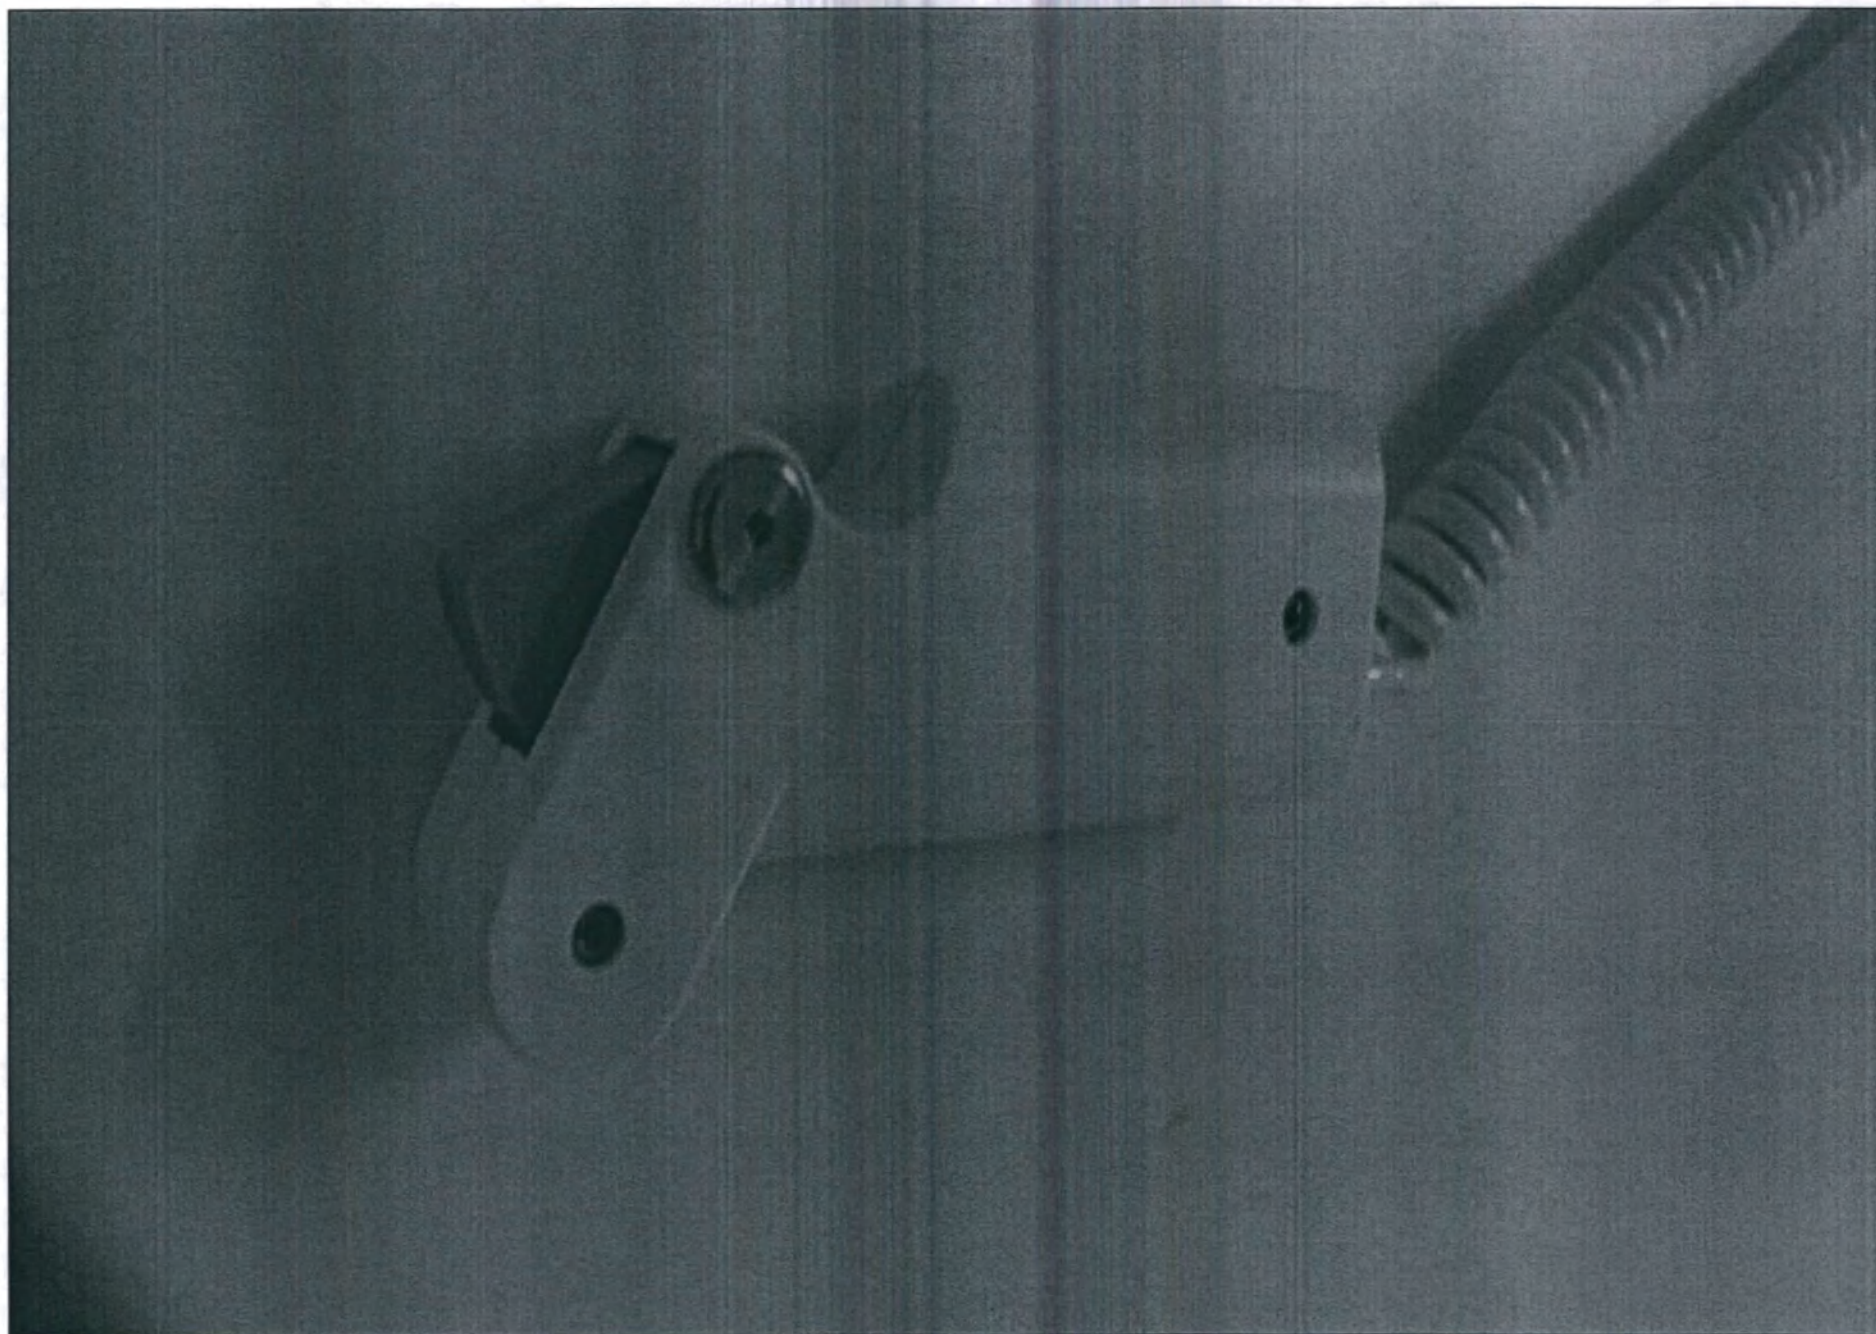


12. Регулятор скорости.

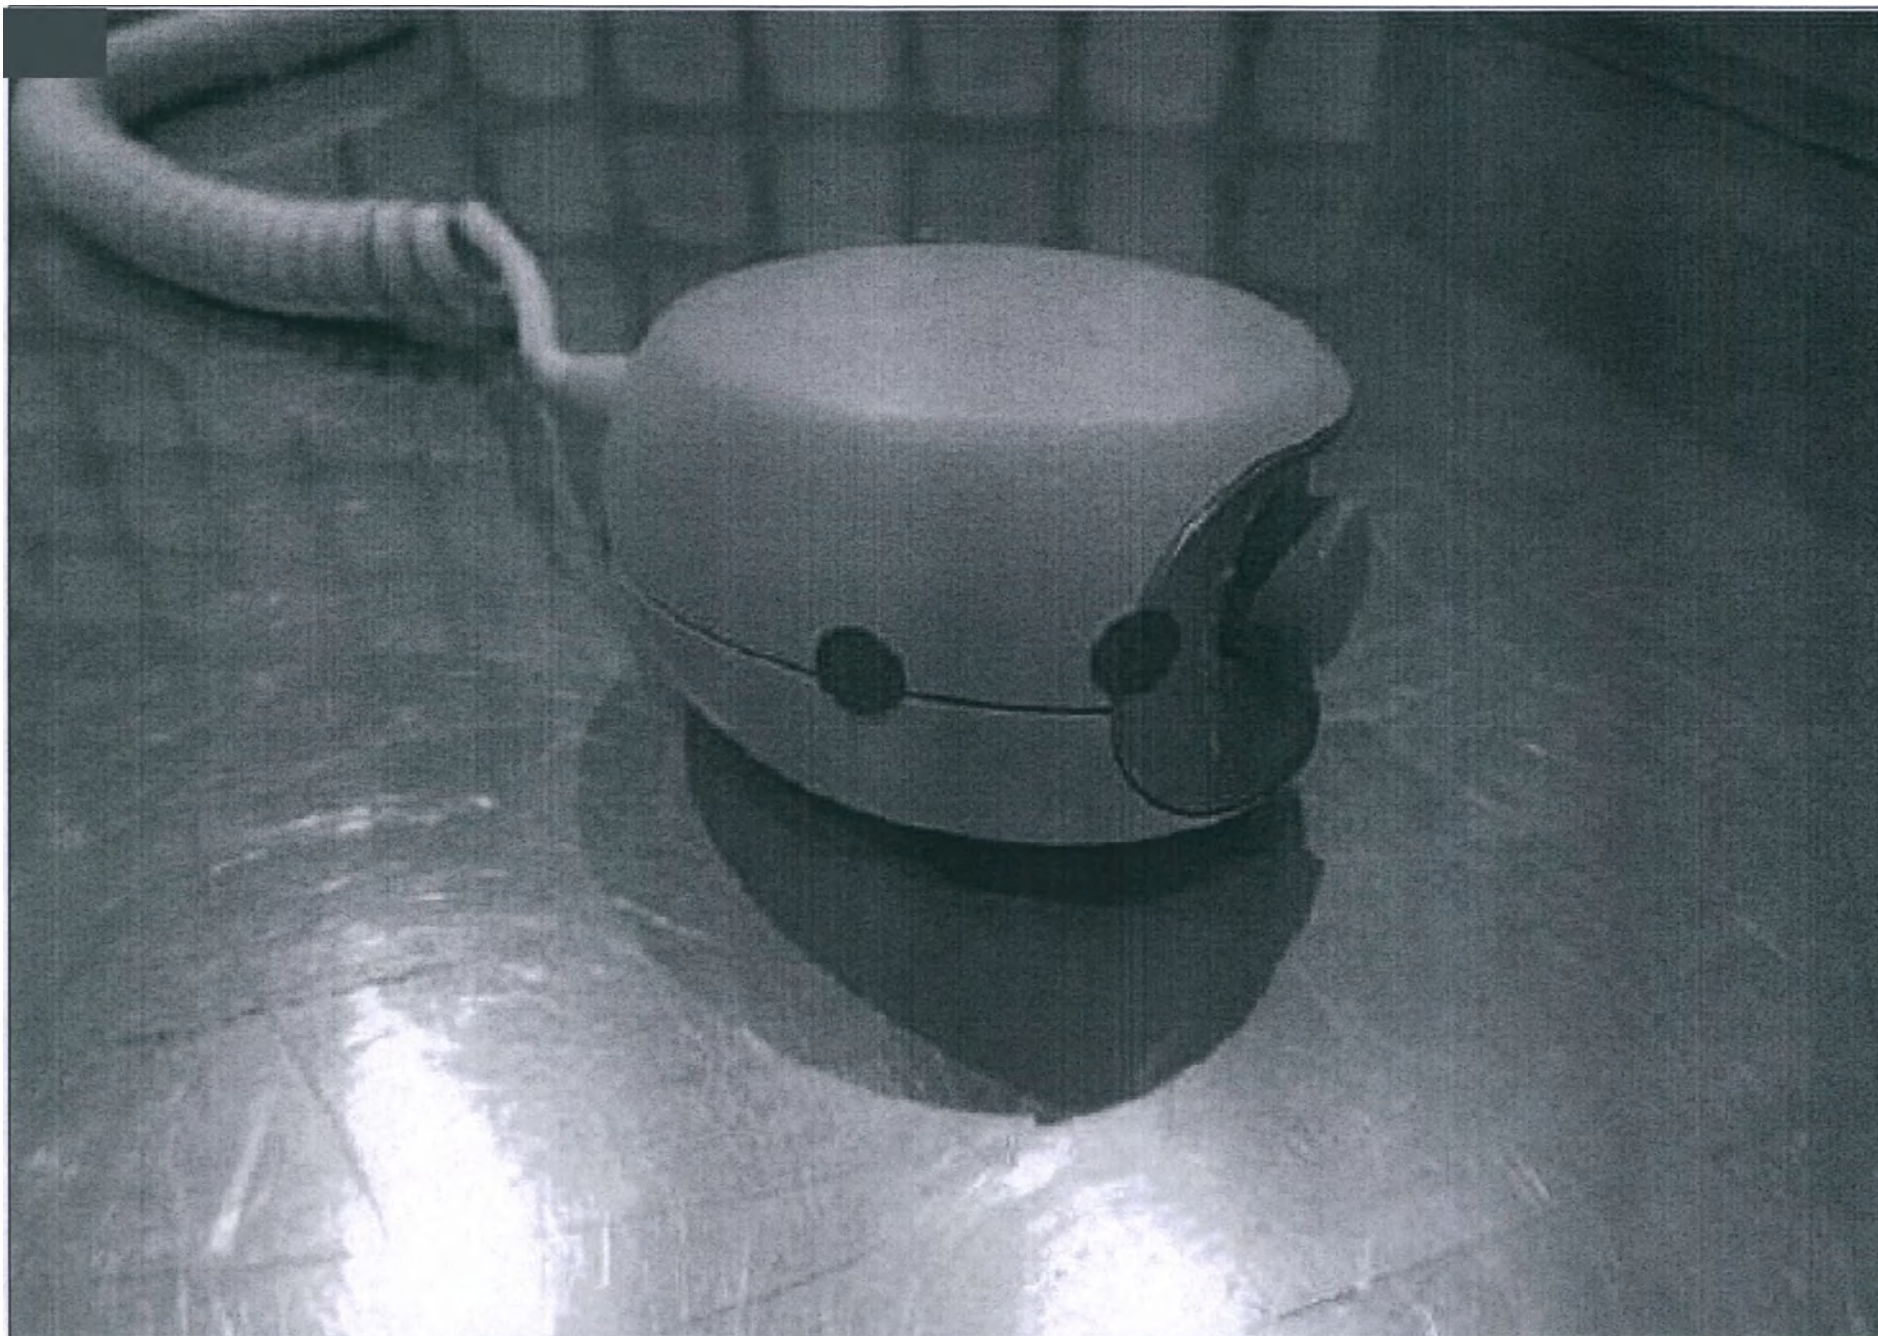


13. Ручной переключатель экспозиции.




14. Ножной переключатель, не более 2 шт.

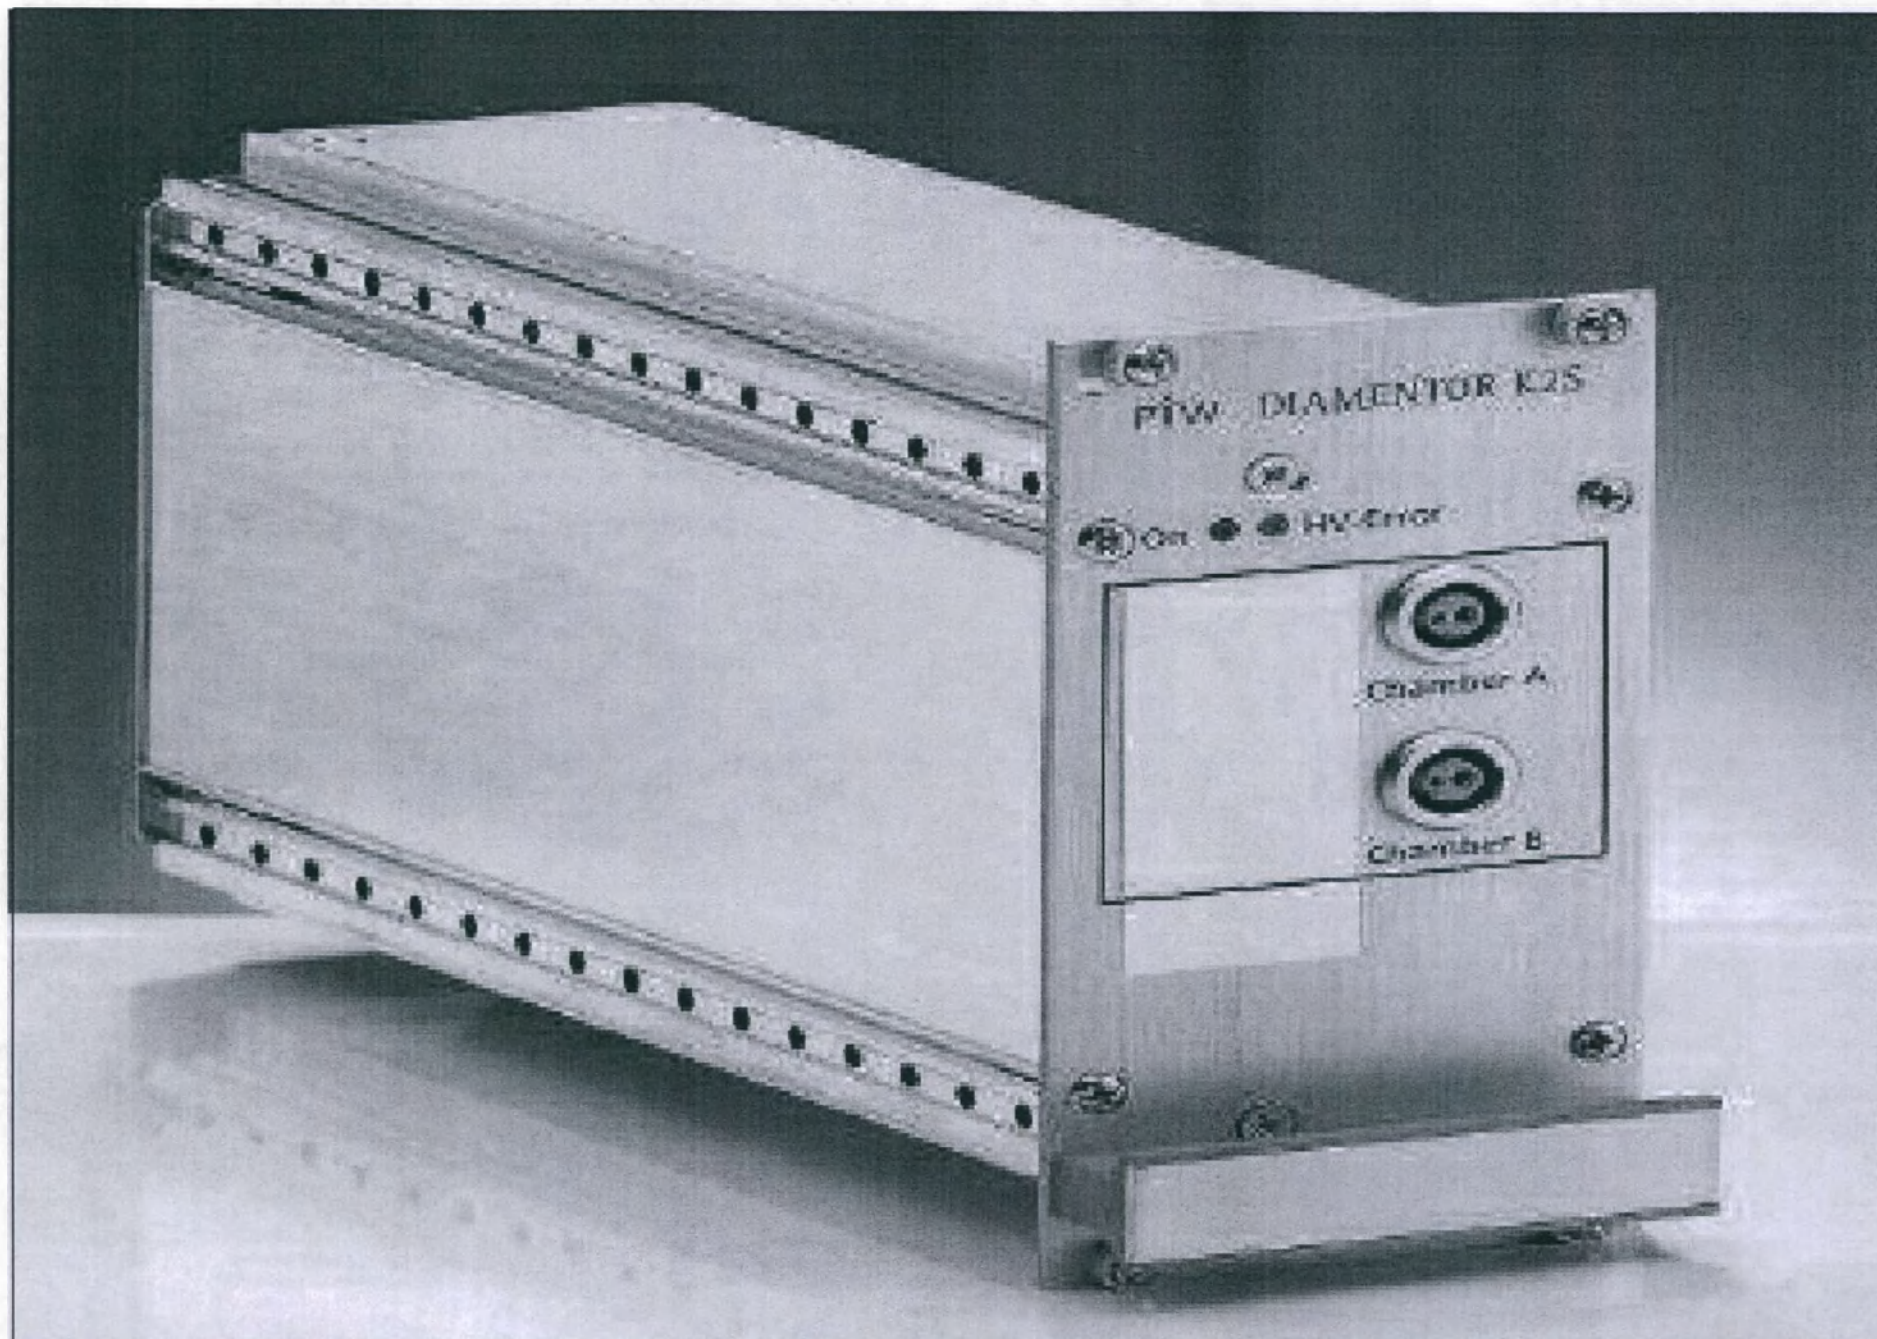


15.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

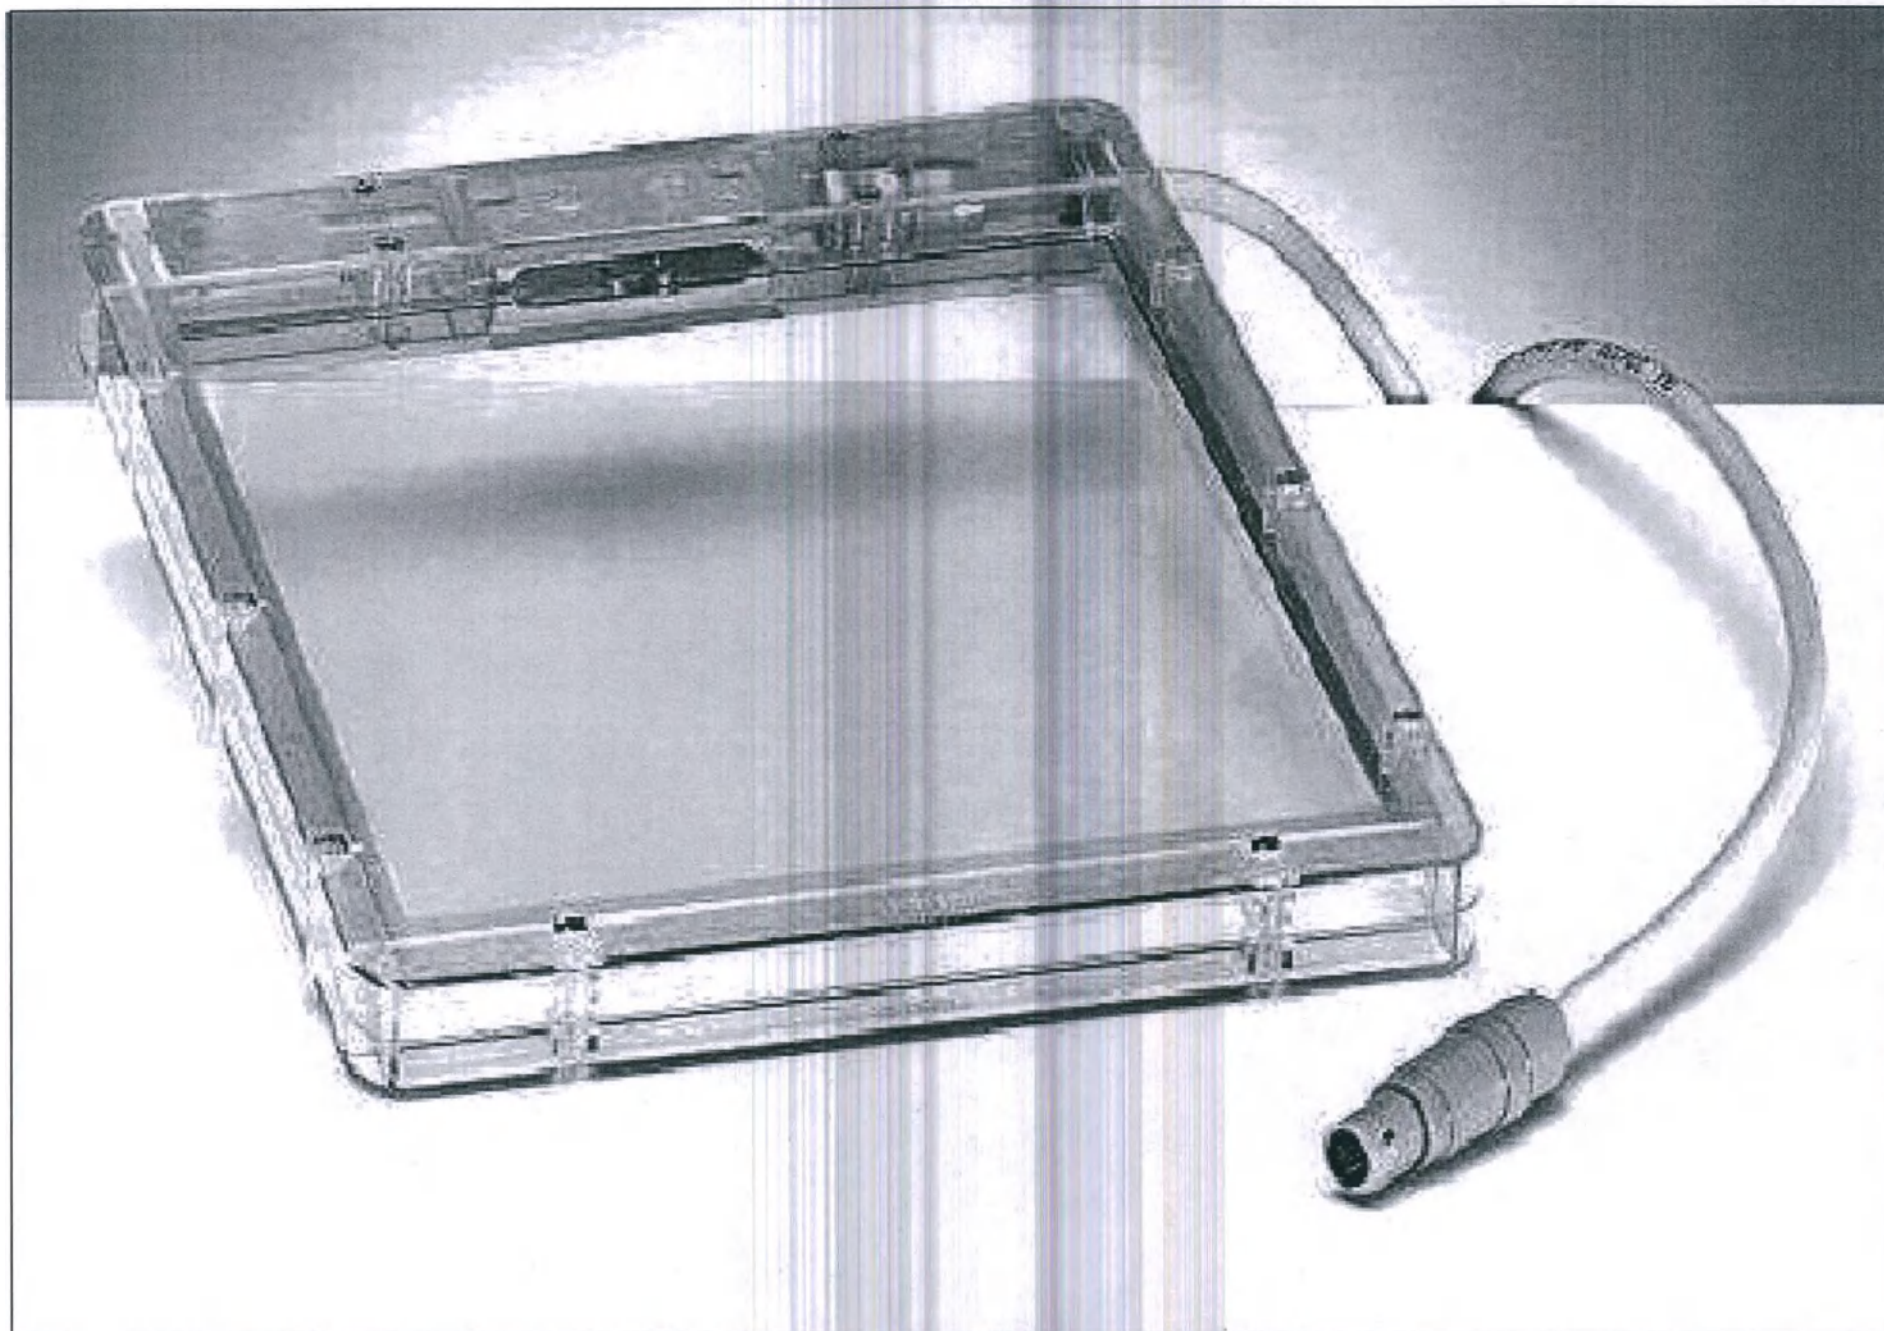


15.6. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДПК-1* или *ДПК-1М*.

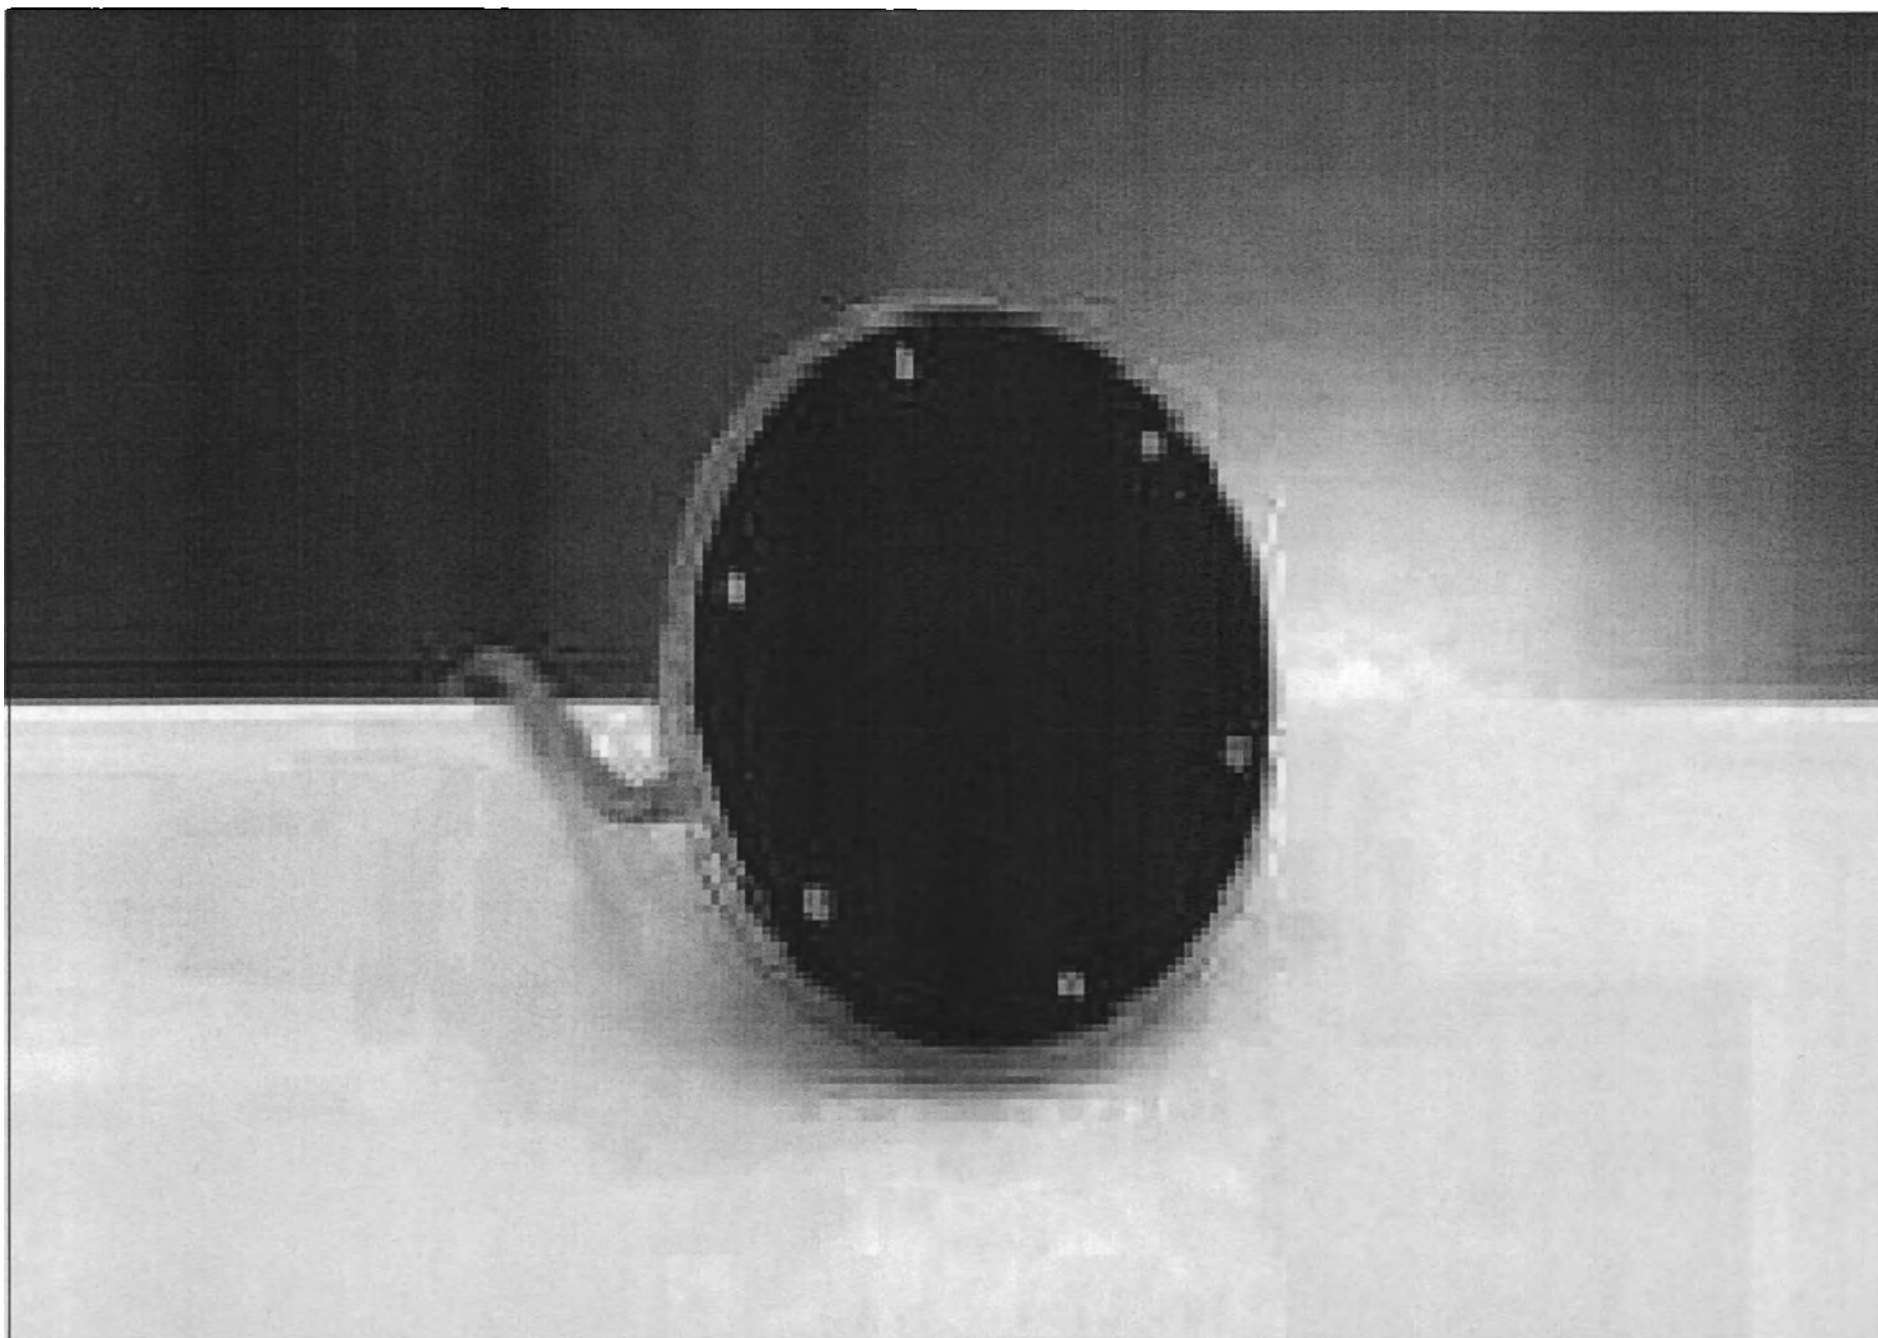


15.в. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

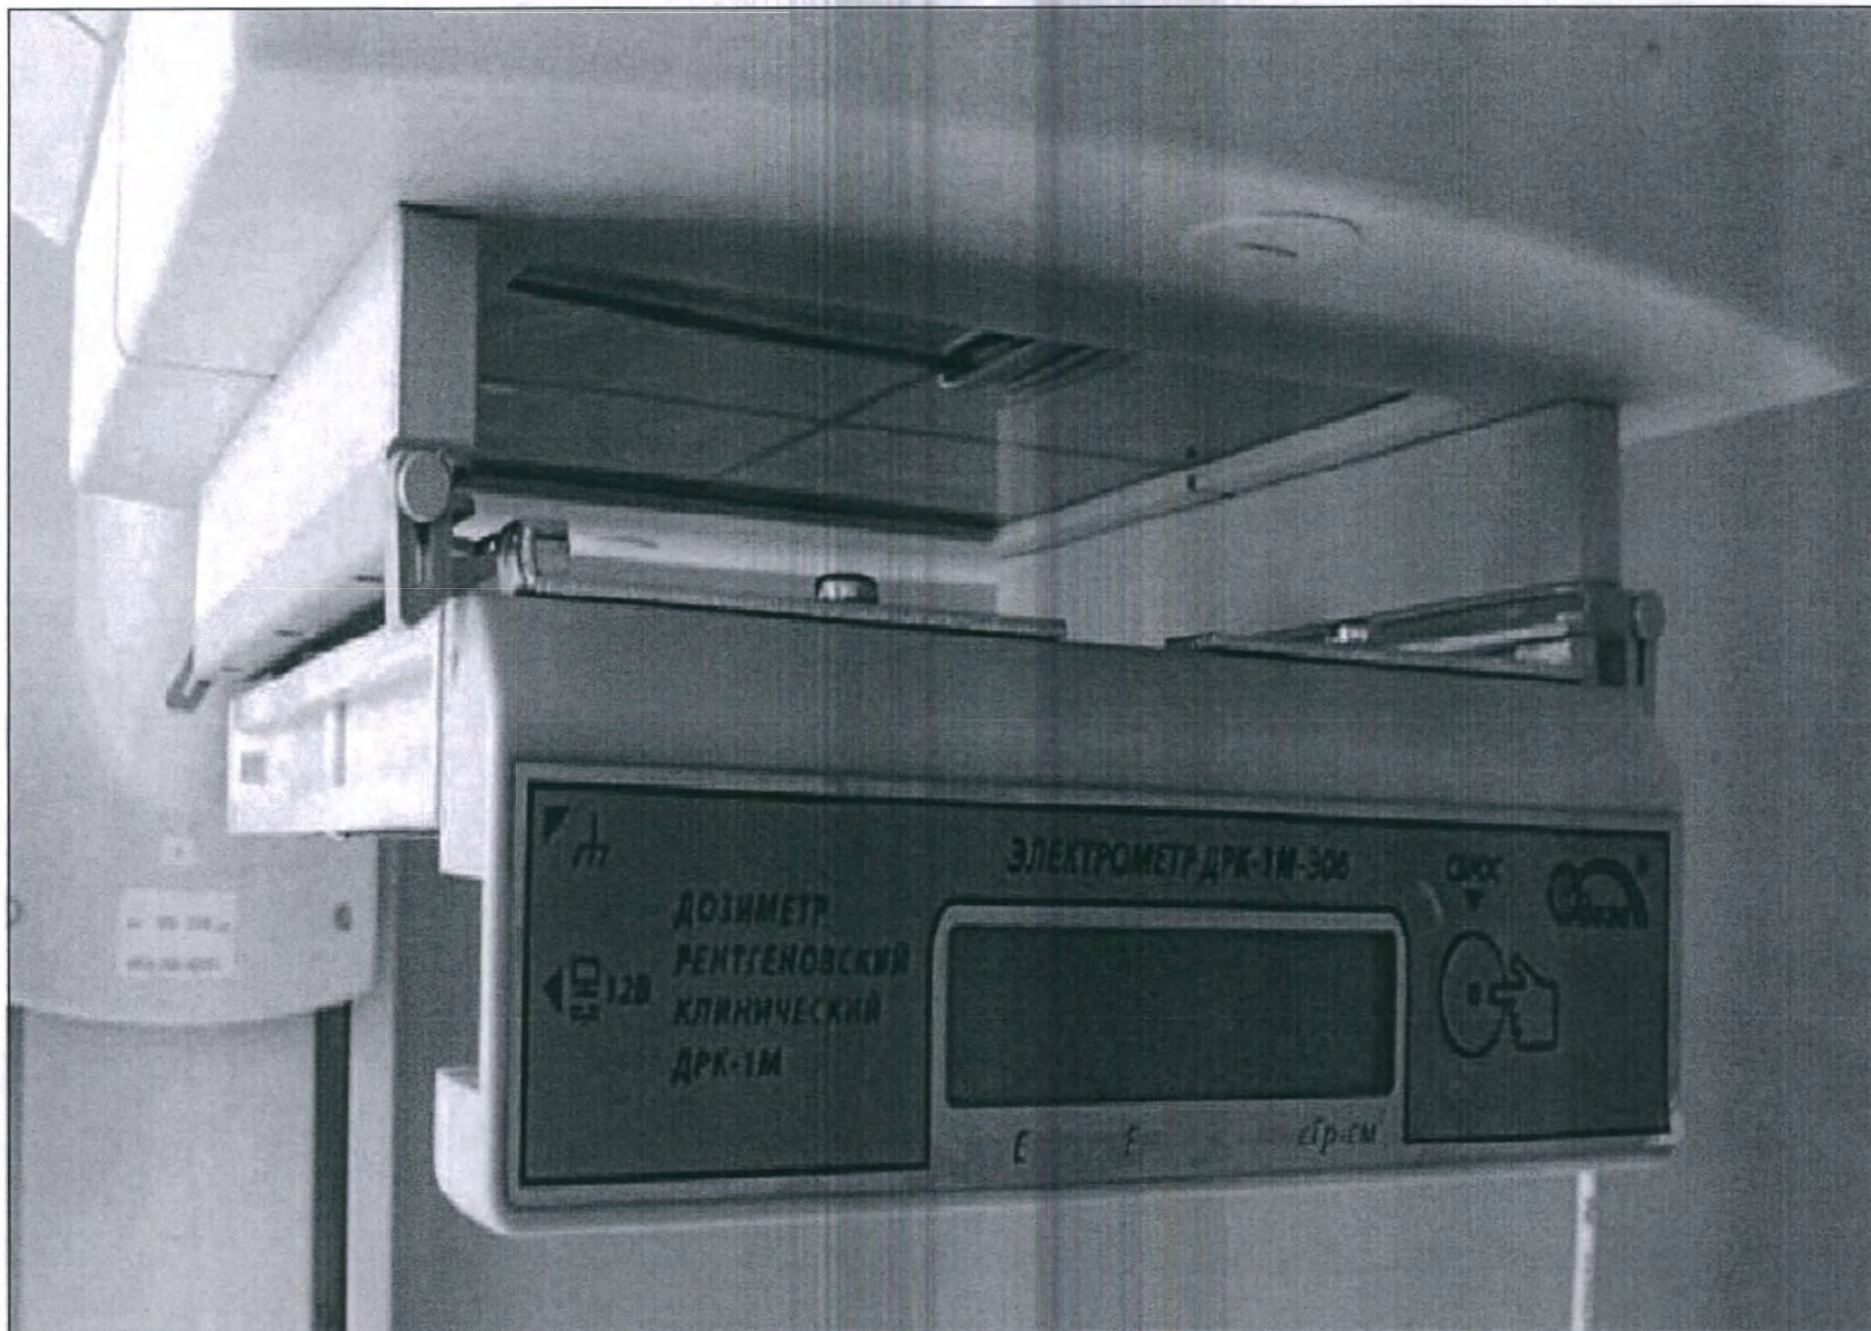


15.з. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

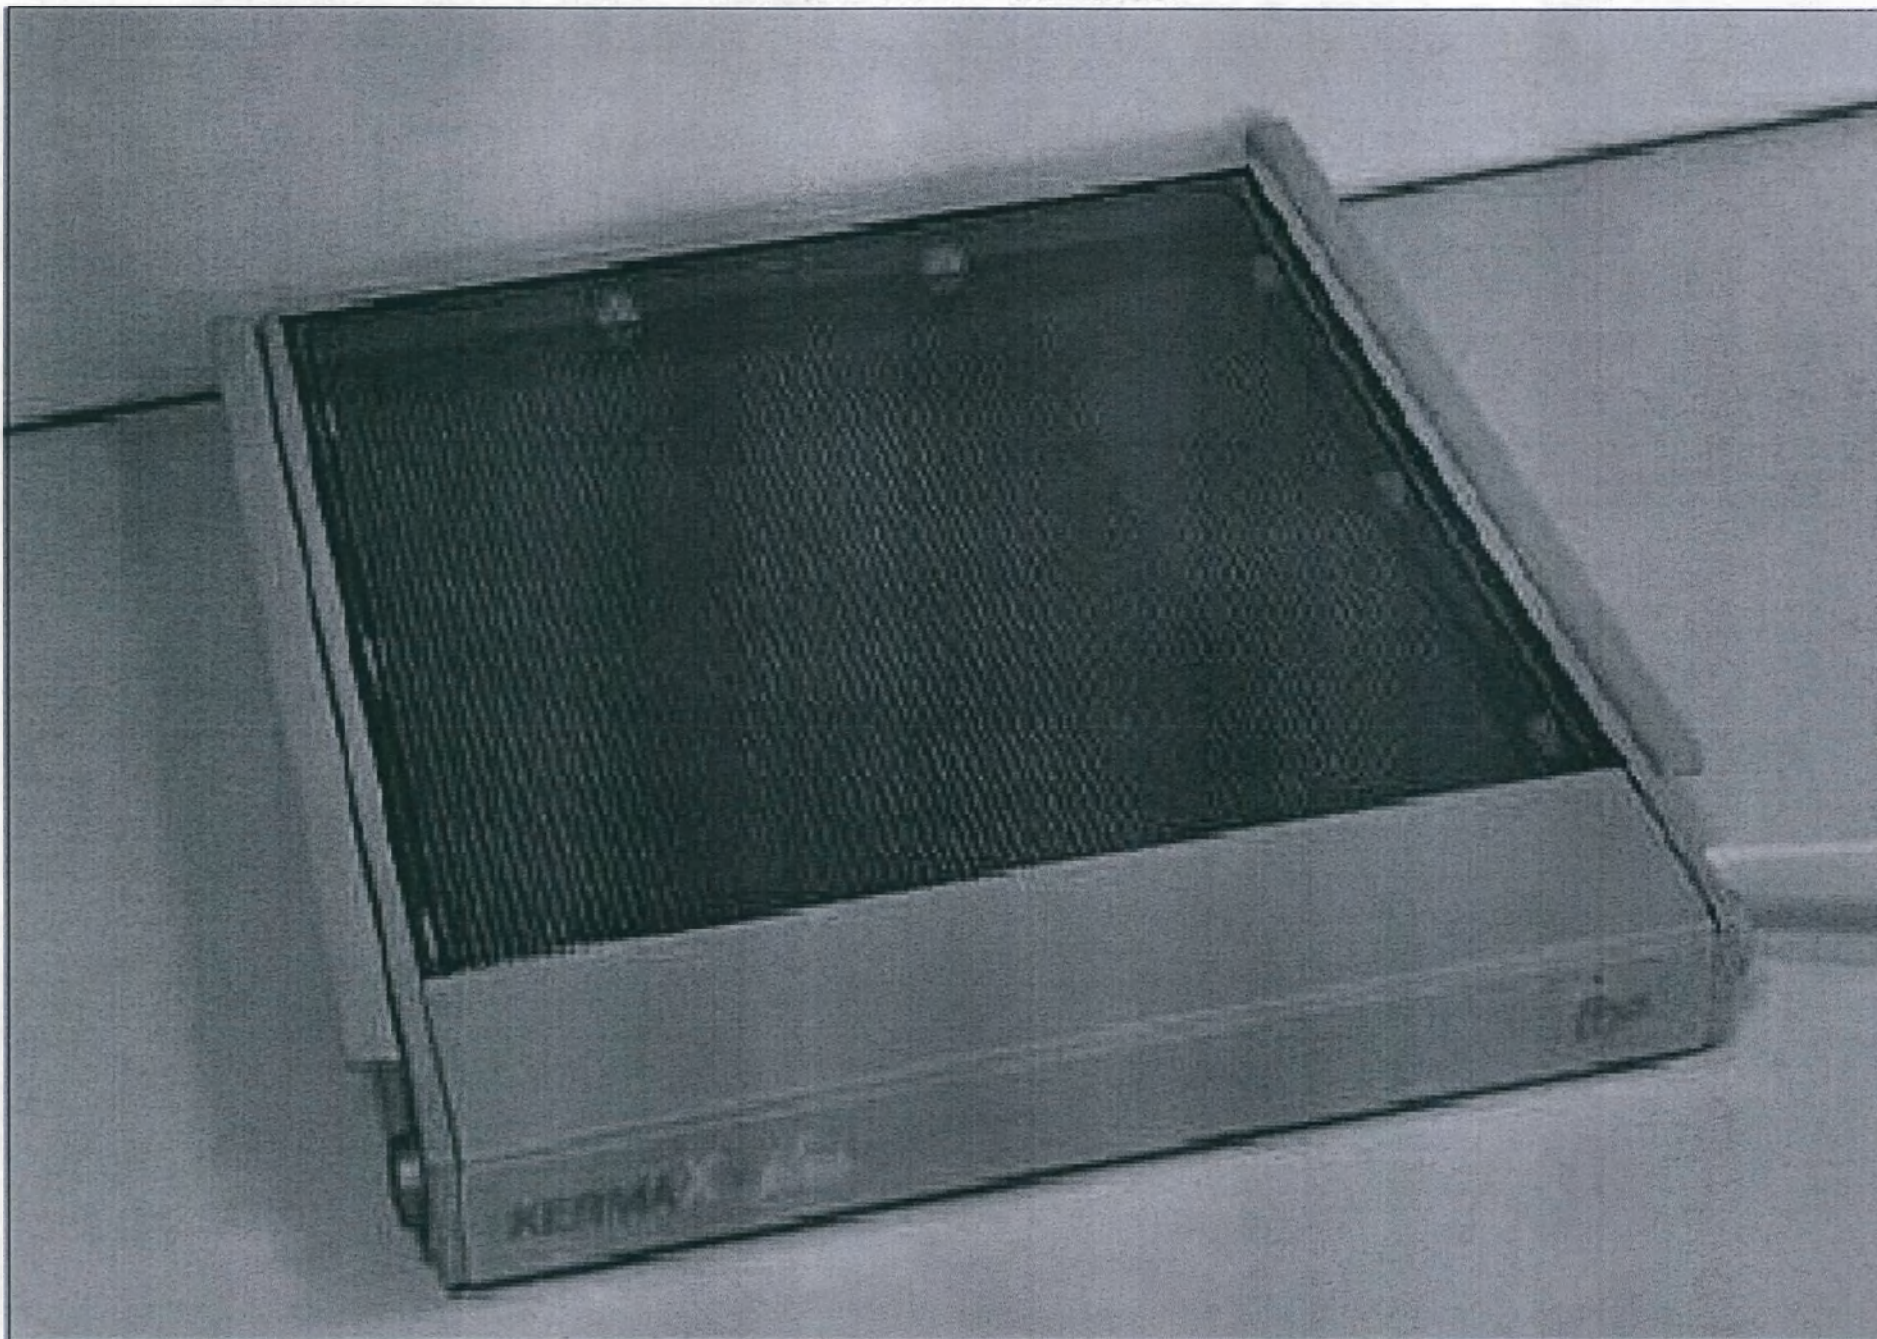


16. Измеритель произведения дозы на площадь KermaX plus 120-132.

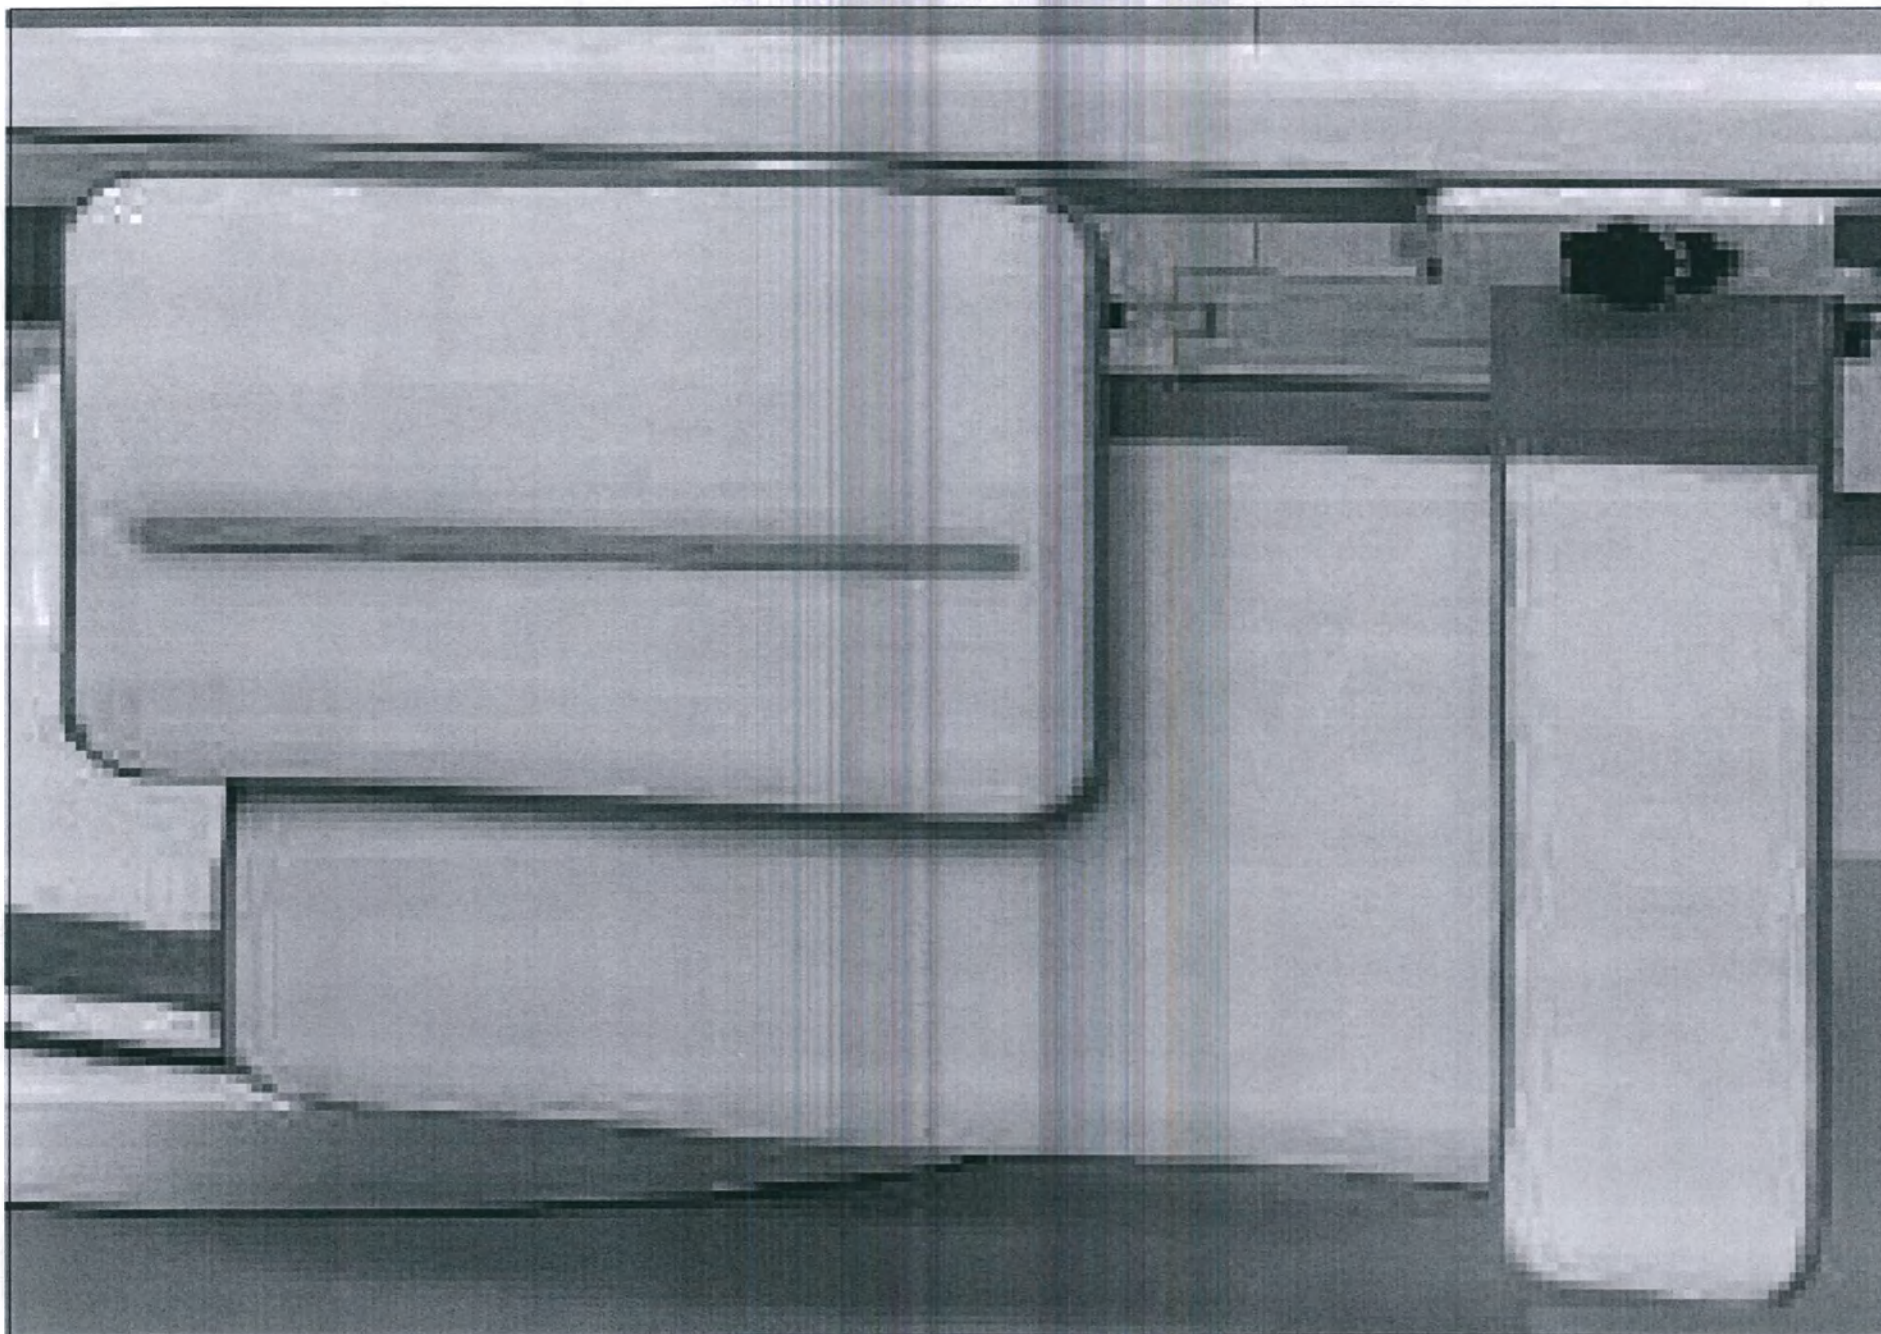


17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

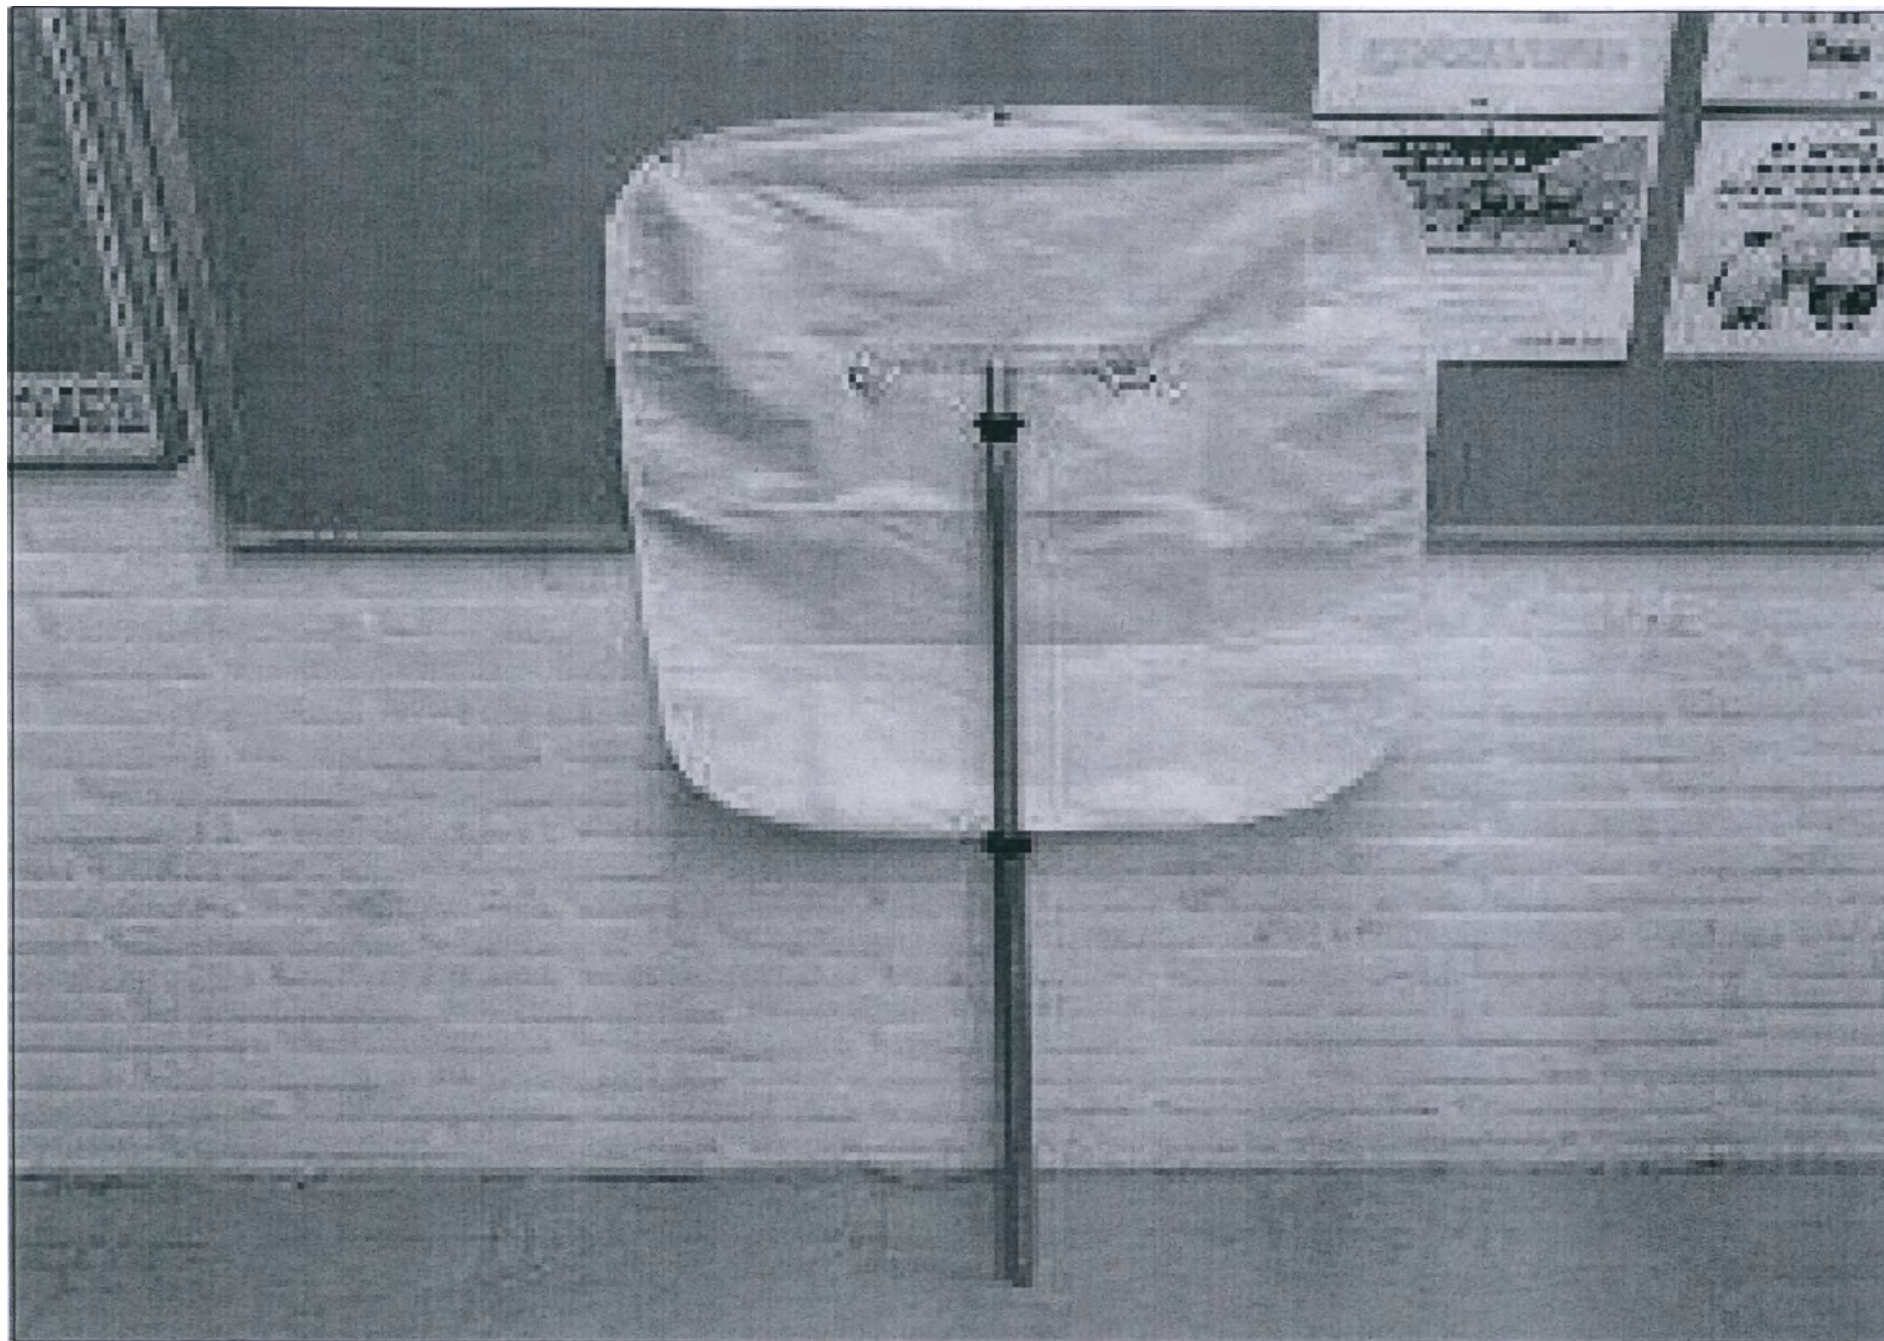


18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

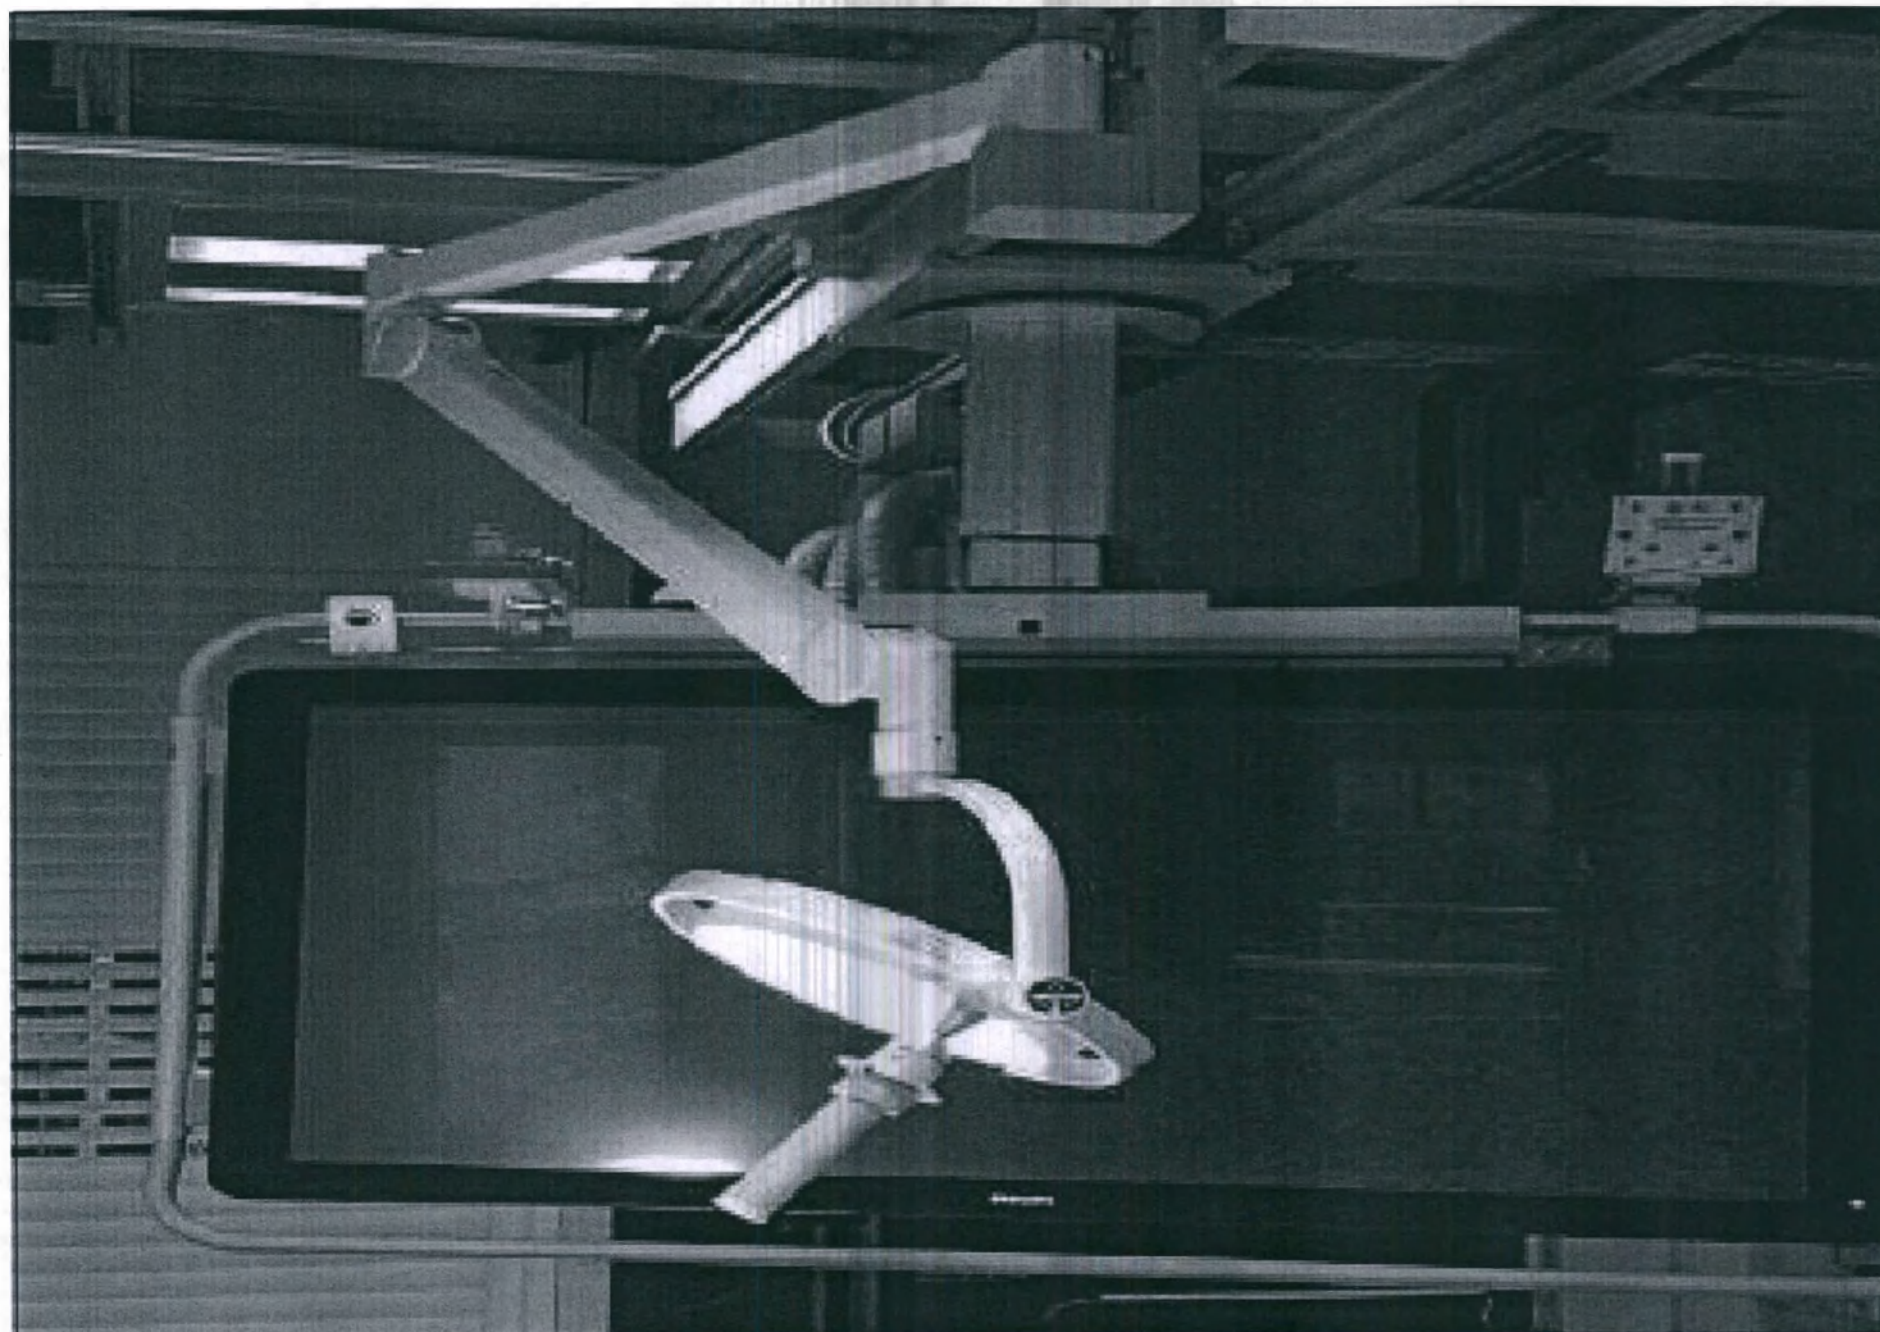

19. Лампа для осмотра.

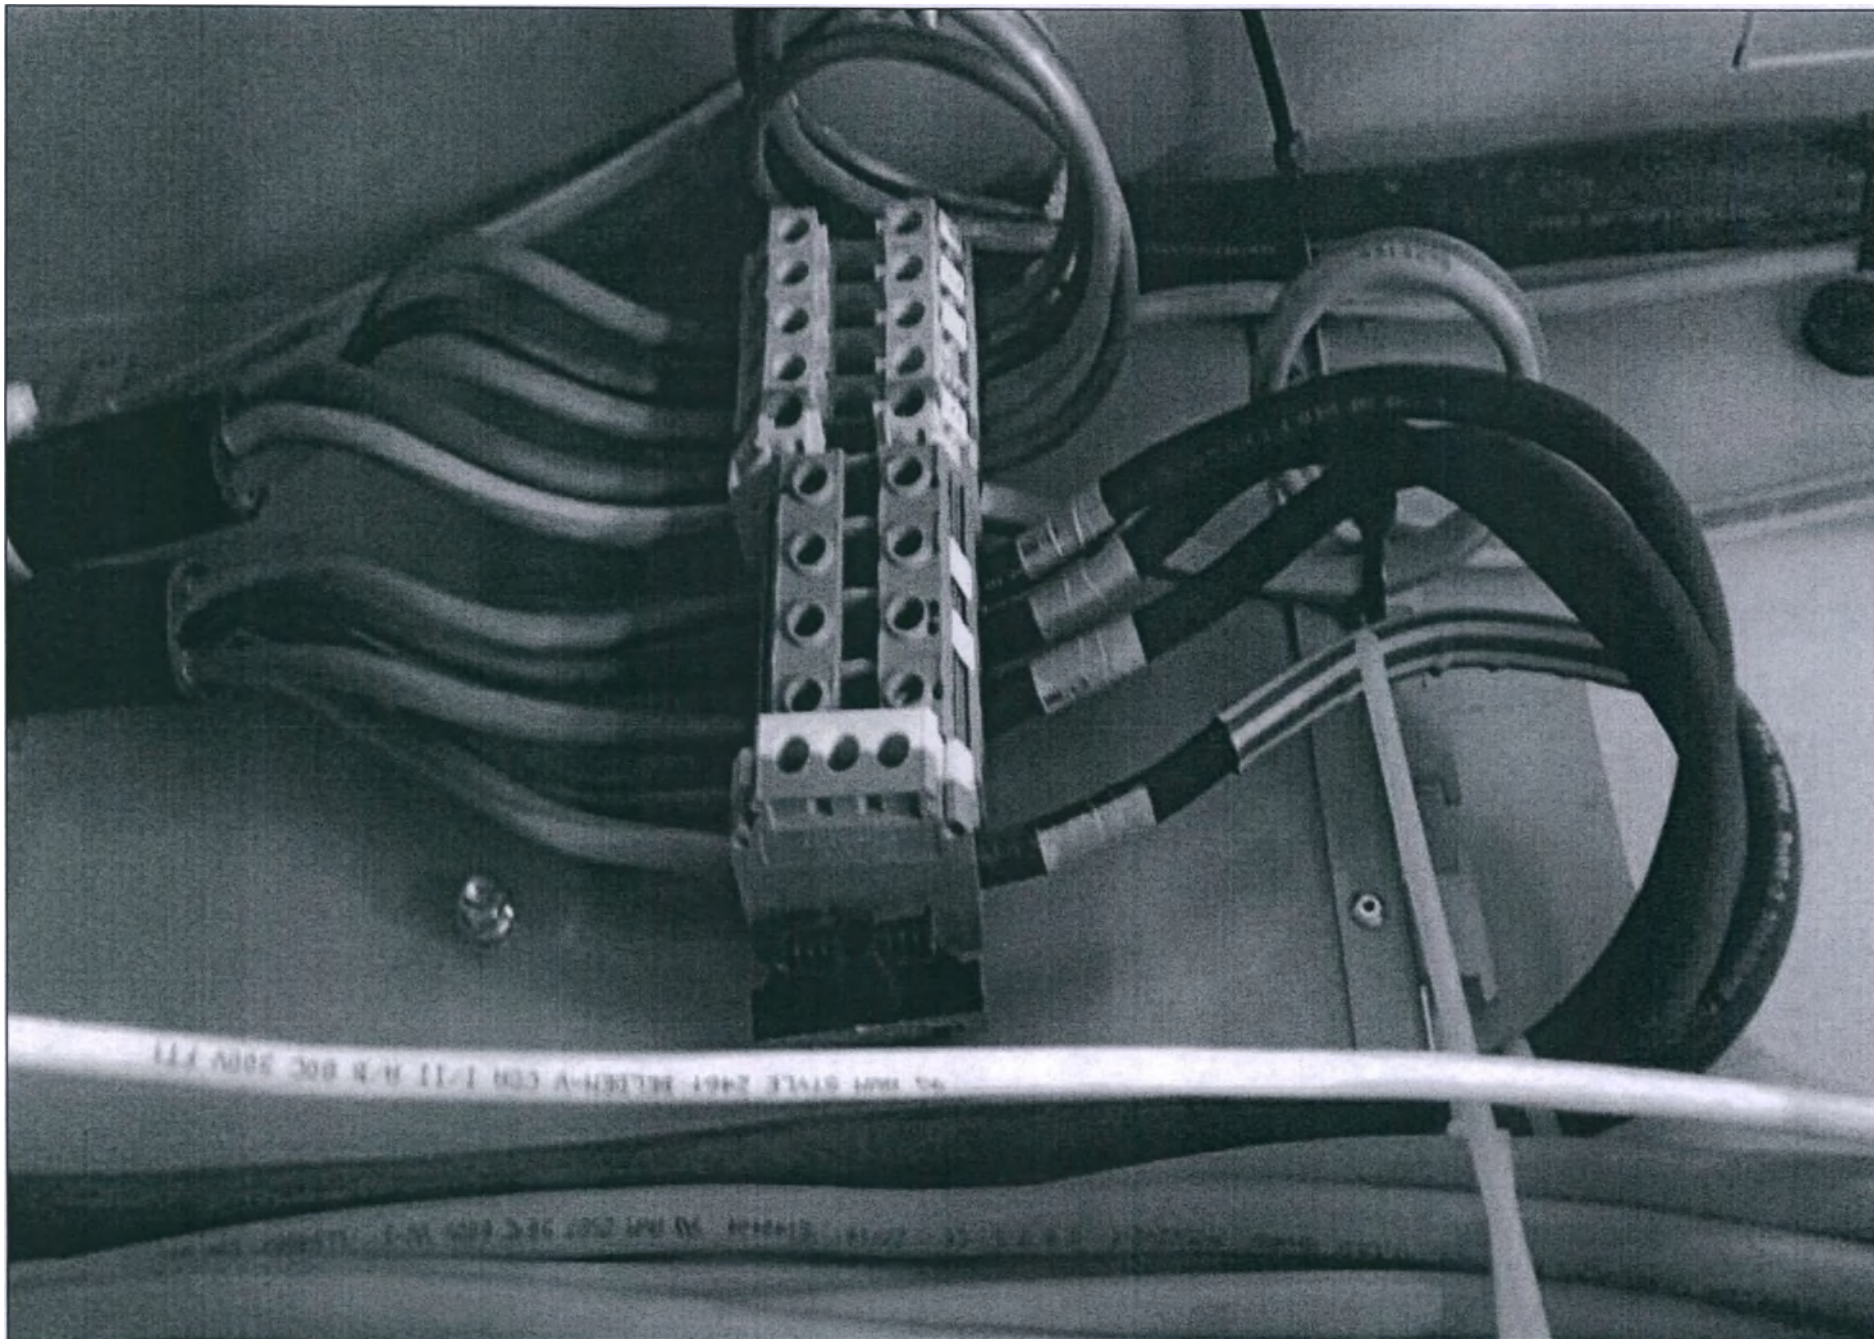

20. Кабели питания.

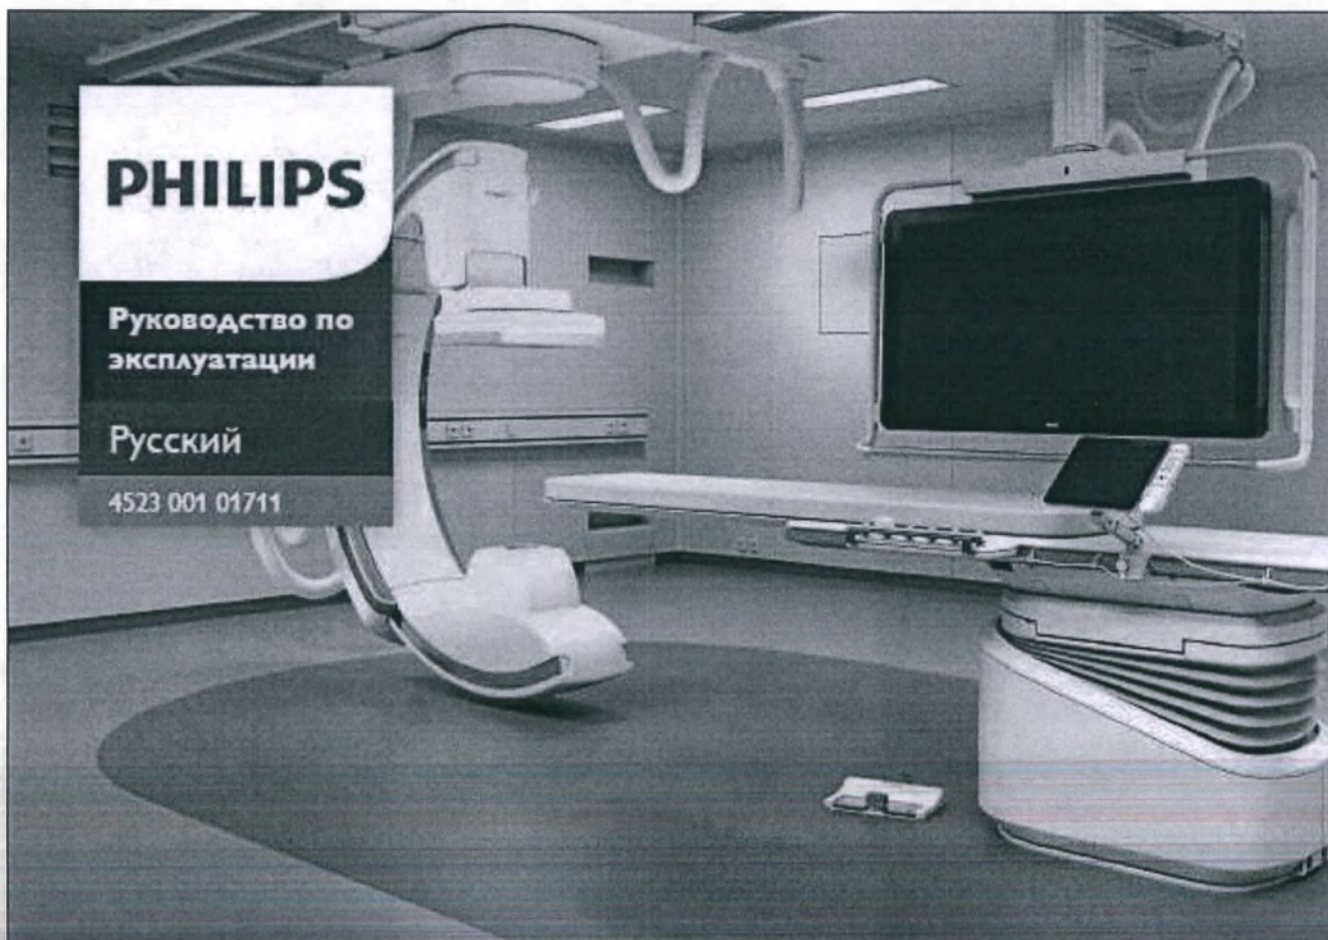

Philips Azurion


Версия 2.2

21.г. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


22. Система хирургической навигации с дополненной реальностью ClarifEye:



22.1.а. Рабочая станция ClarifEye: - системный блок с программным приложением для системы дополненной реальности ClarifEye версия 1.0 и выше; - цветной монитор с диагональю 24 дюйма; - клавиатура; - мышь.

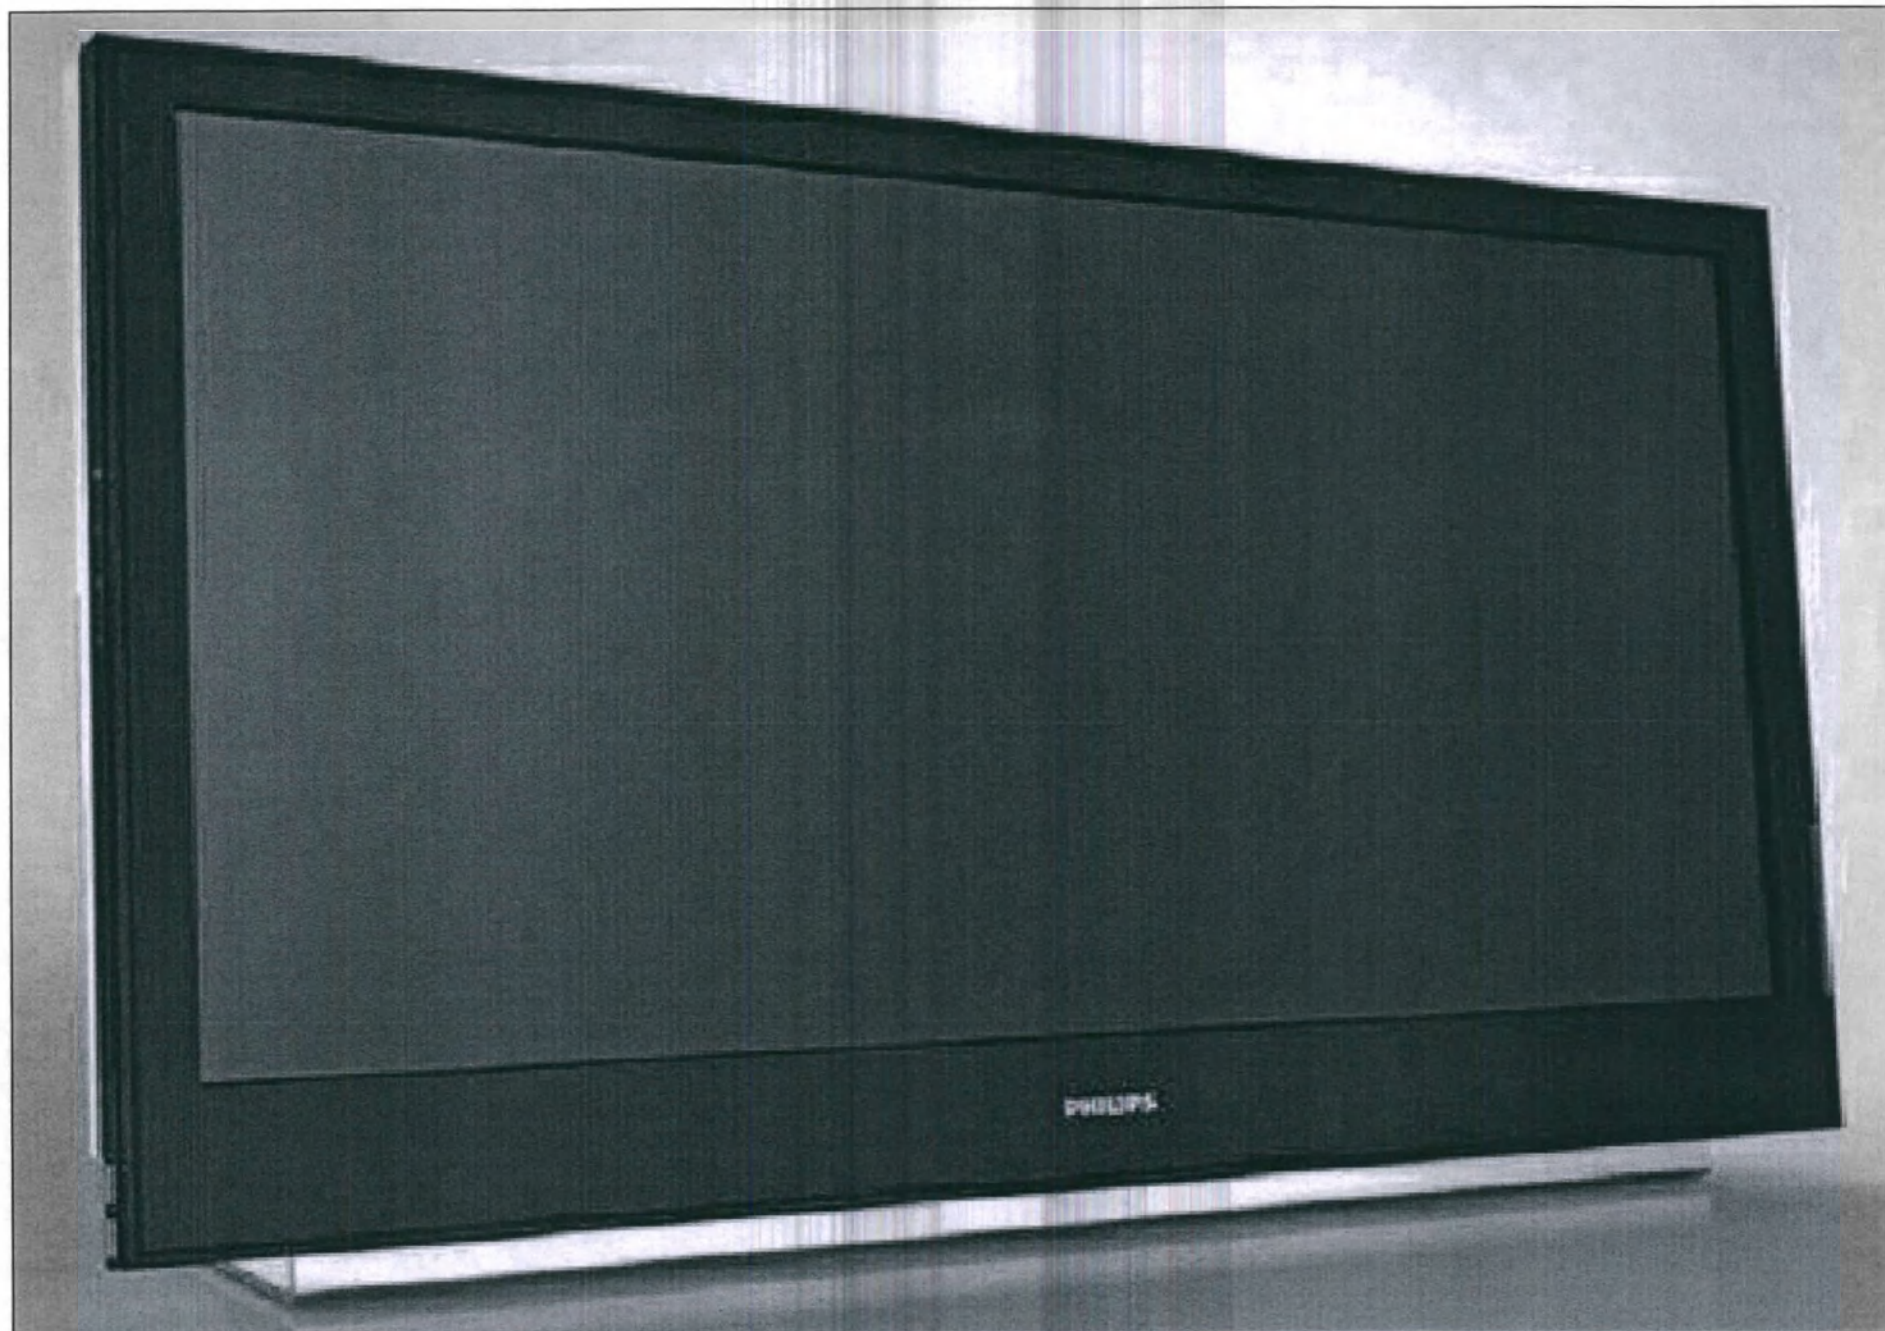

22.1.6. Рабочая станция ClarifEye: - системный блок с программным приложением для системы дополненной реальности ClarifEye версия 1.0 и выше; - цветной монитор с диагональю 24 дюйма; - клавиатура; - мышь.

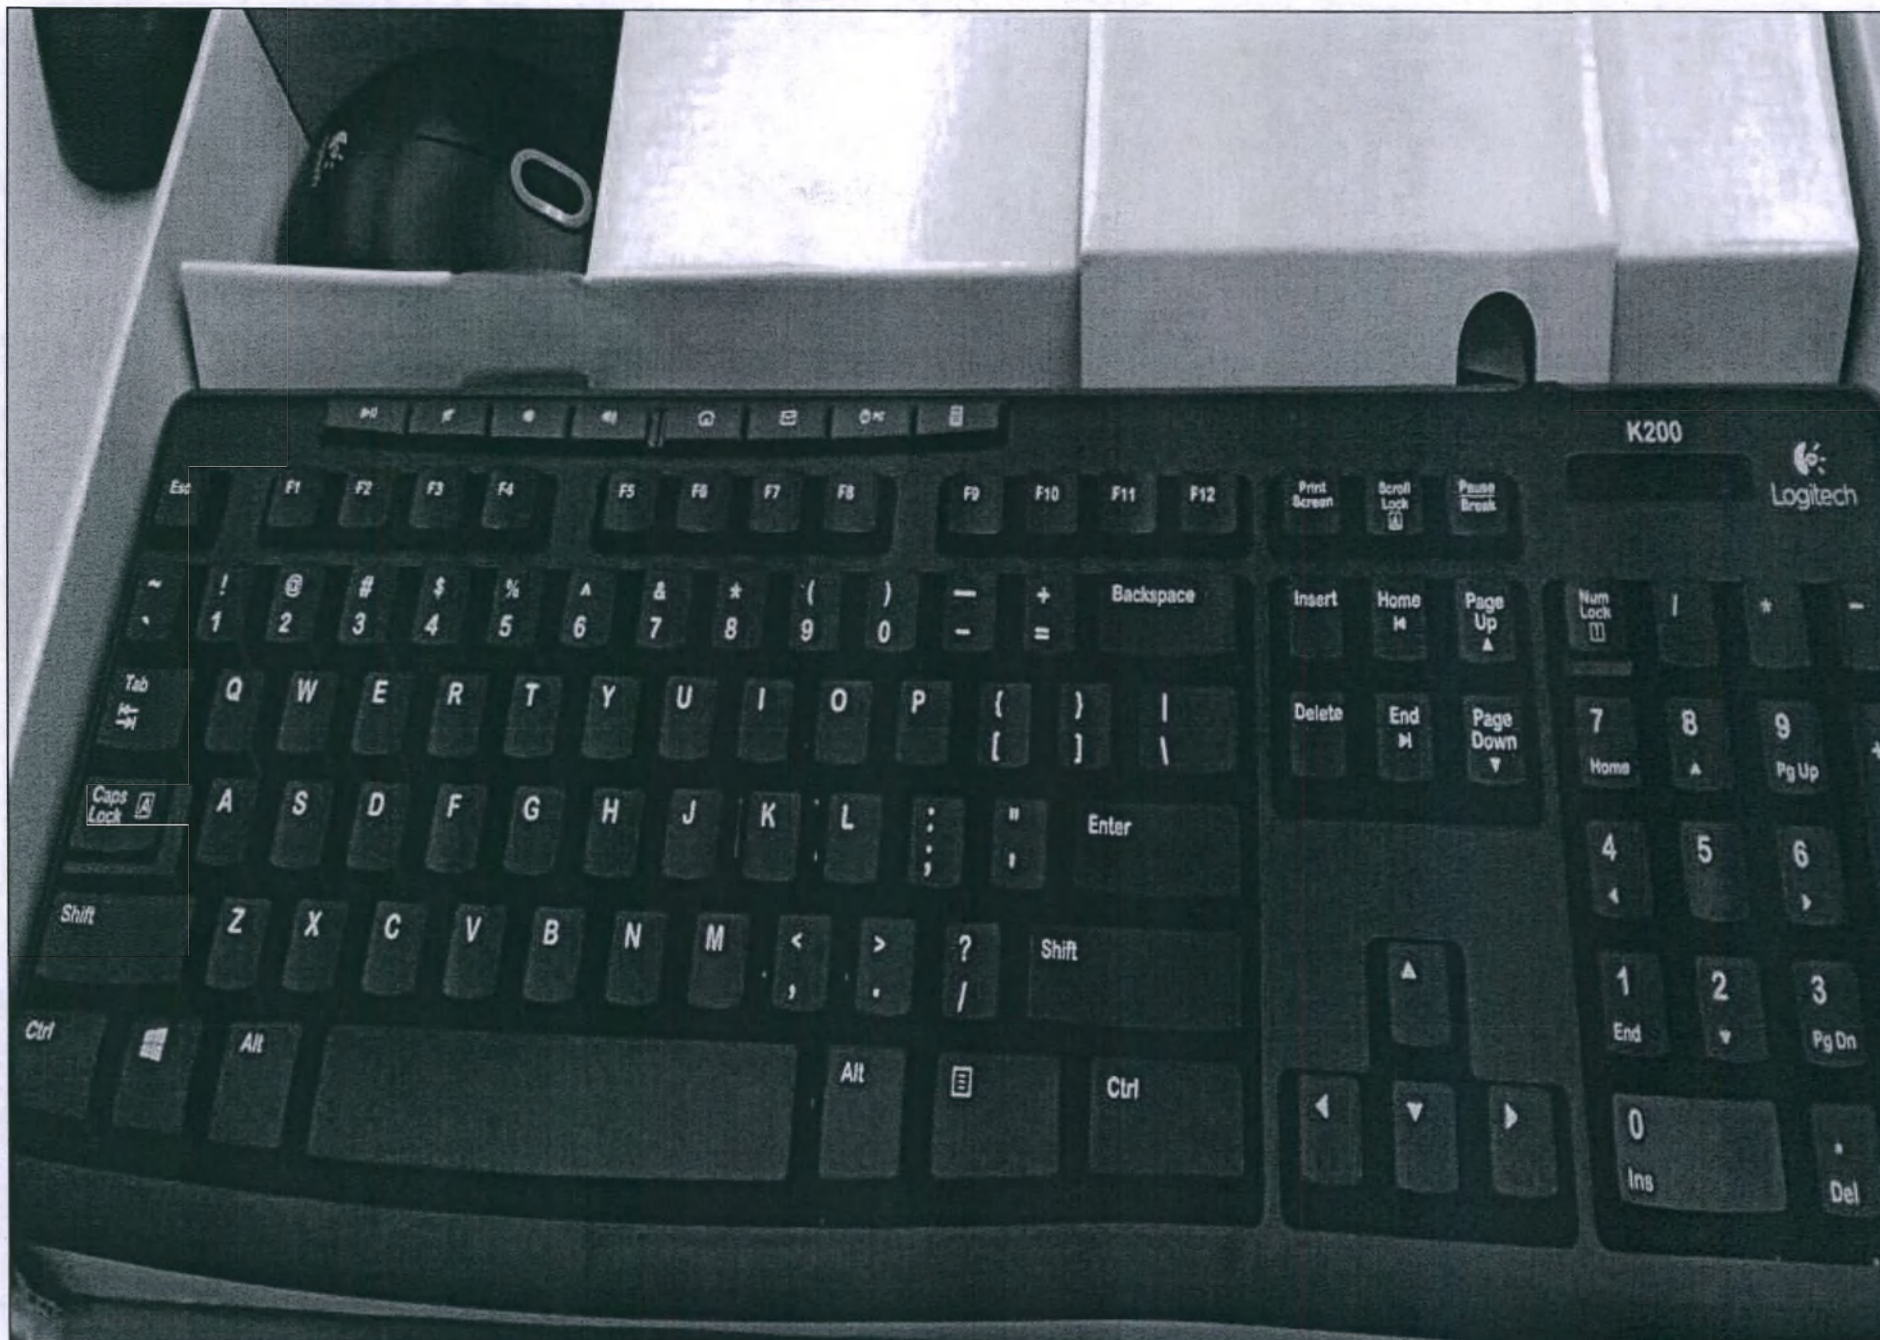


22.1.в. Рабочая станция ClarifEye: - системный блок с программным приложением для системы дополненной реальности ClarifEye версия 1.0 и выше; - цветной монитор с диагональю 24 дюйма; - клавиатура; - мышь.




22.1.2. Рабочая станция ClarifEye: - системный блок с программным приложением для системы дополненной реальности ClarifEye версия 1.0 и выше; - цветной монитор с диагональю 24 дюйма; - клавиатура; - *мышь*.



22.2.a. Приложение программное ClarifEye на электронном носителе.

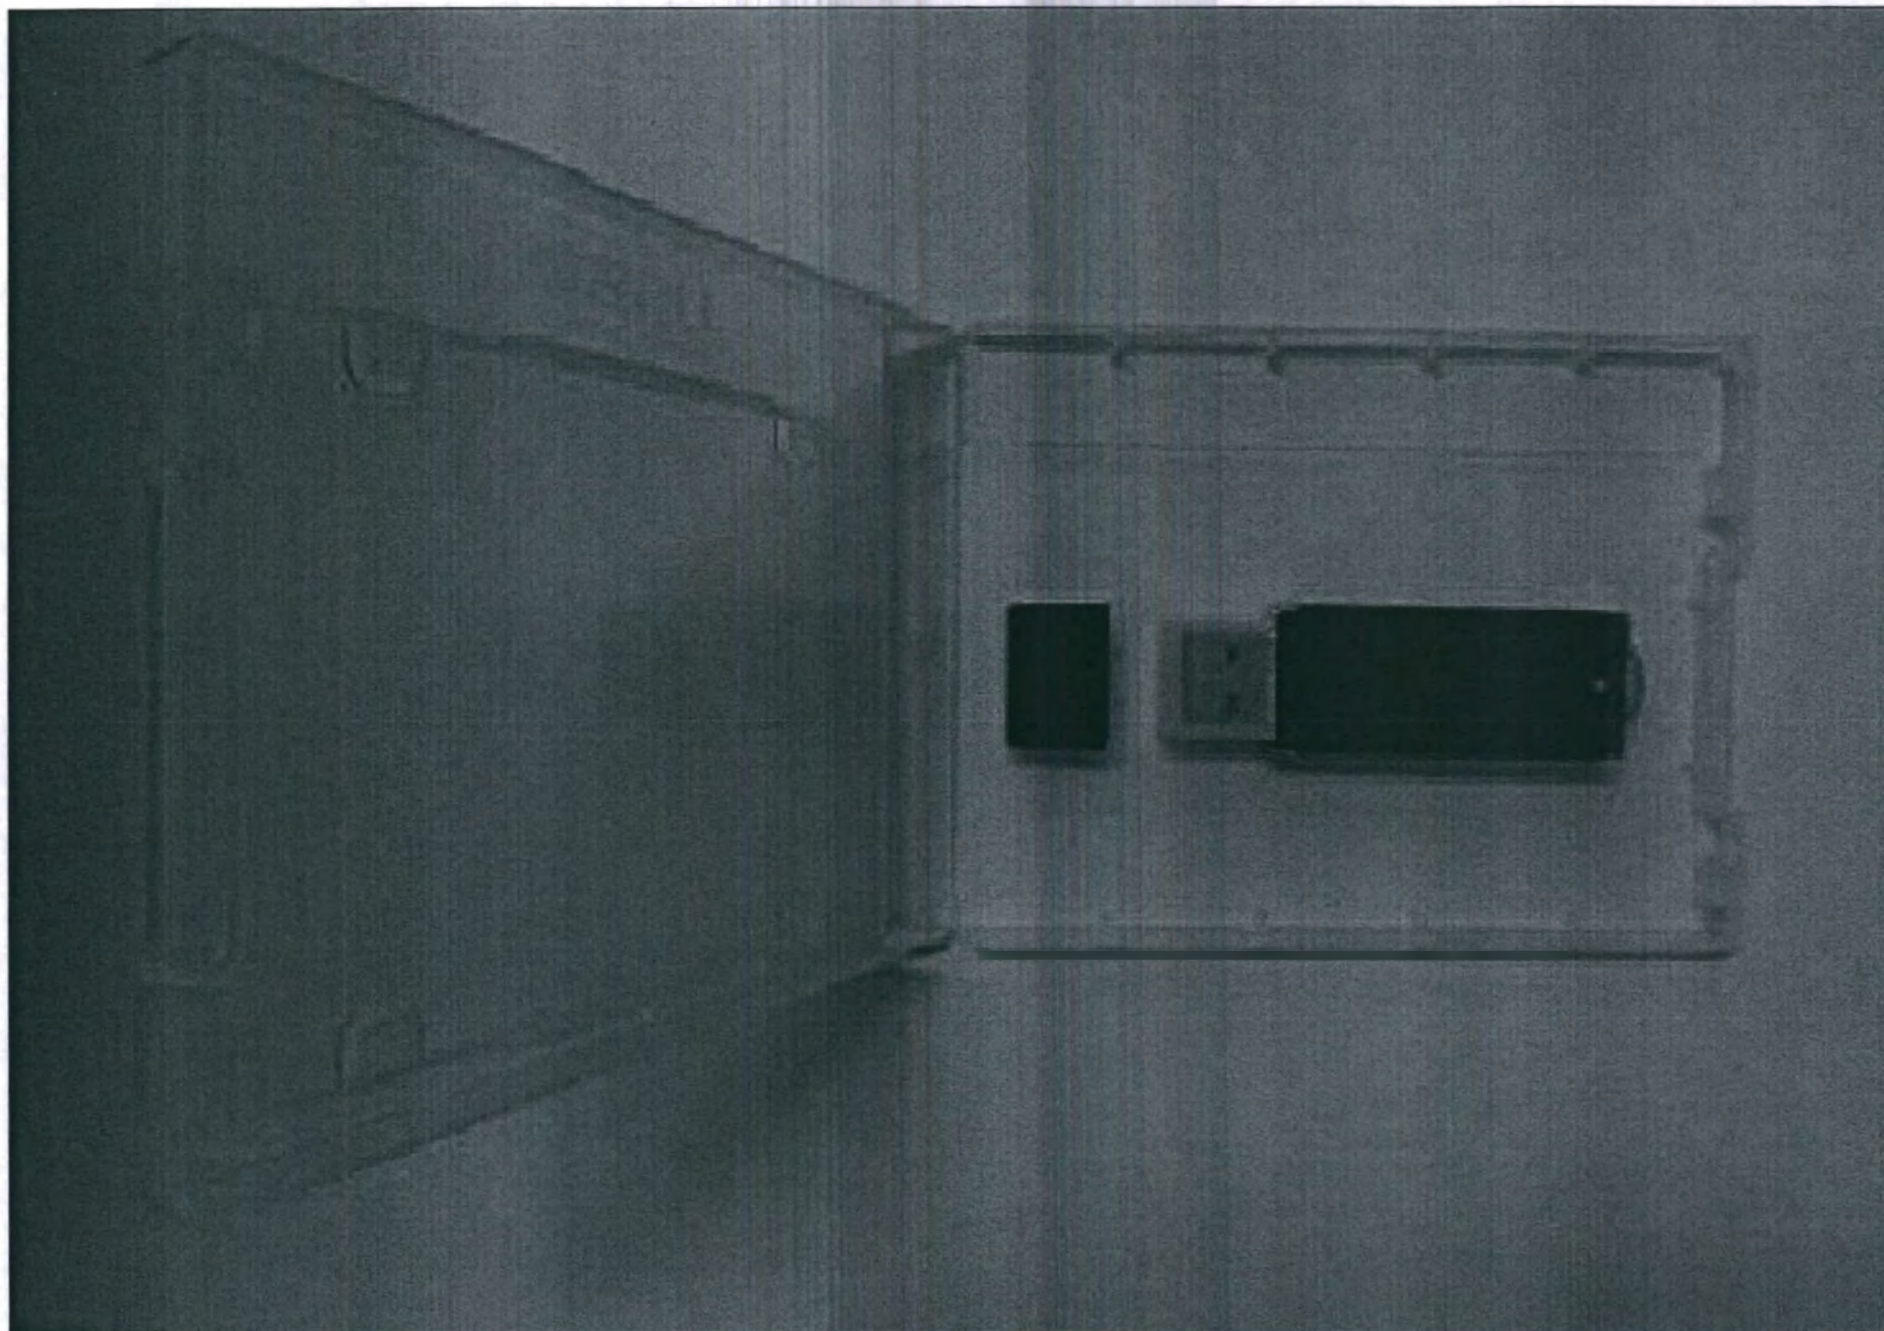


22.2. б. Приложение программное ClarifEye на электронном носителе.

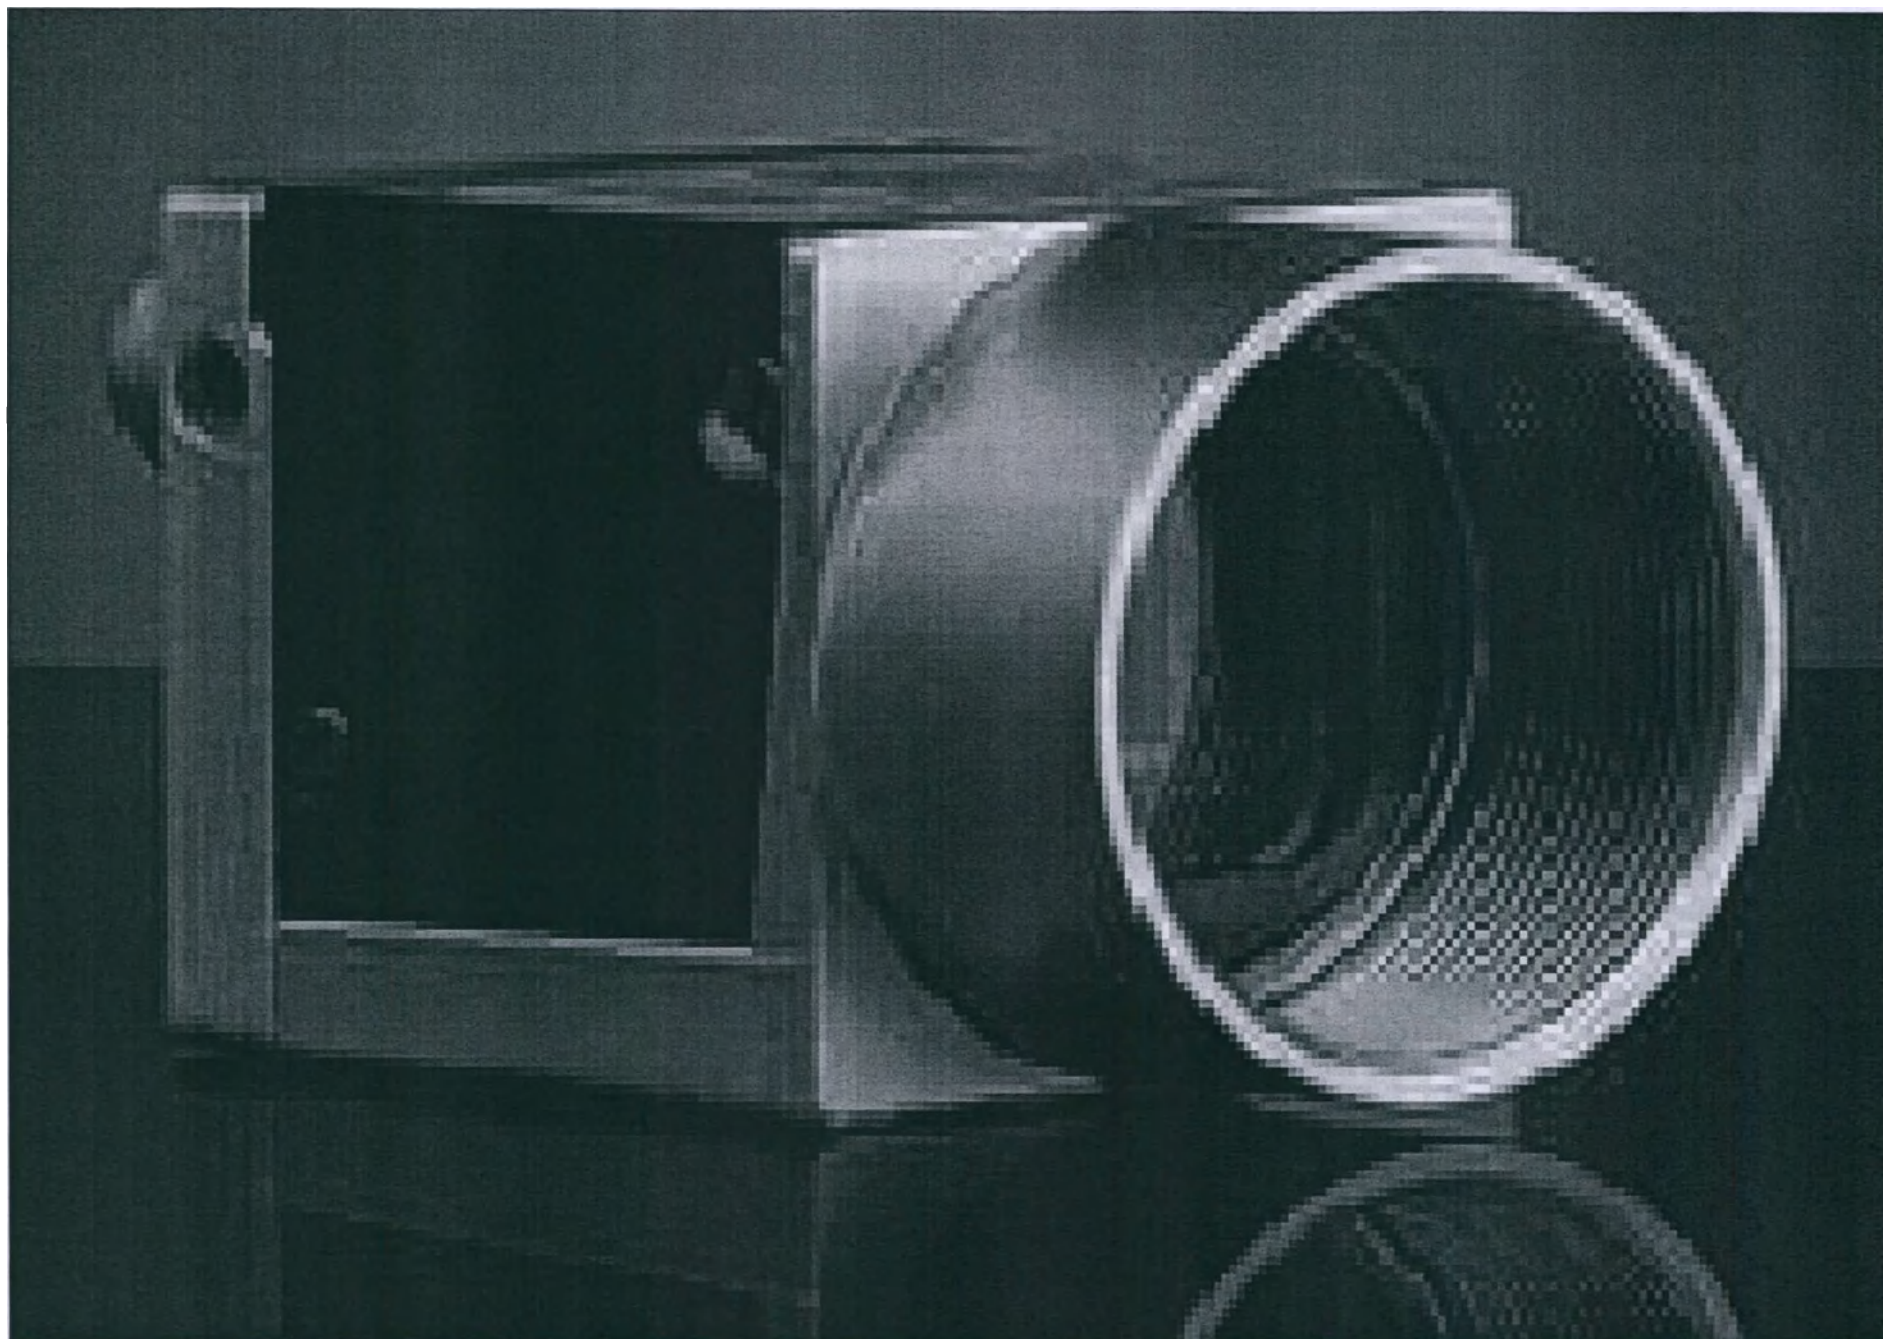


22.3.а. Камеры для детектора С20, не более 4 шт.




22.3.б. Камеры для детектора С20, не более 4 шт.

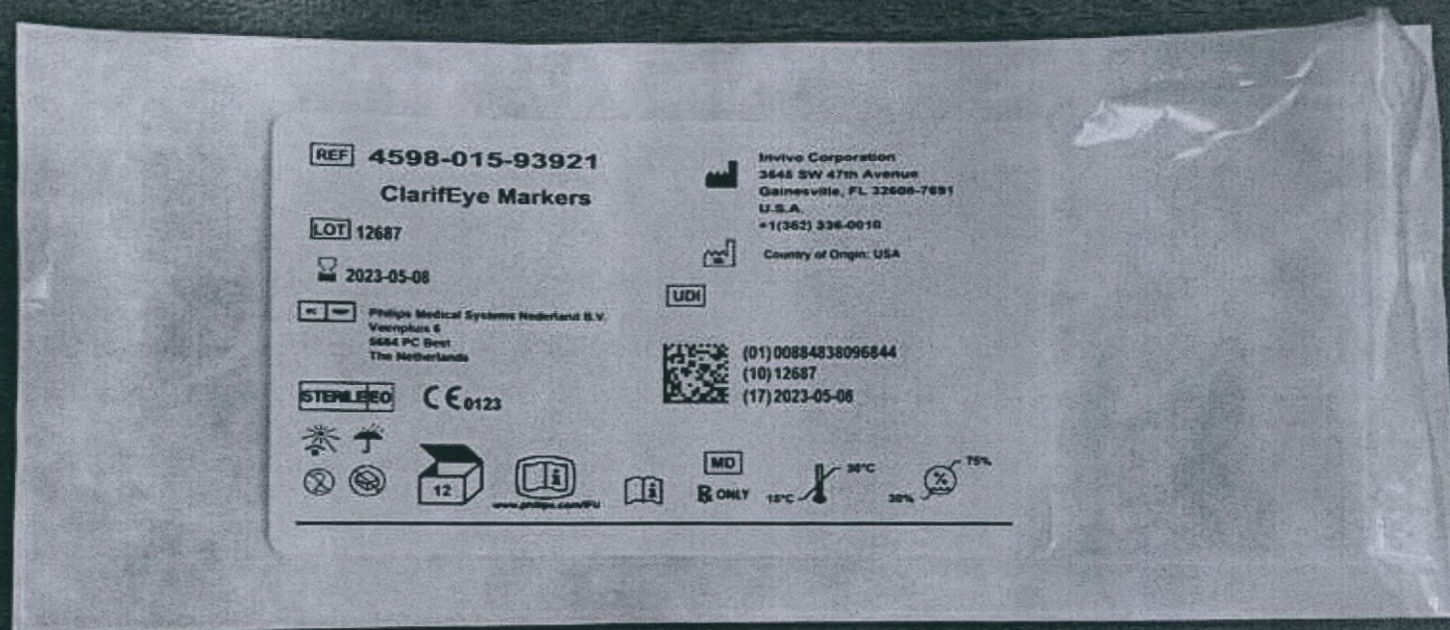


22.4.a. Маркеры кожные оптические стерильные одноразовые ClarifEye Marker, 240 шт./уп. (не более 20 уп.)

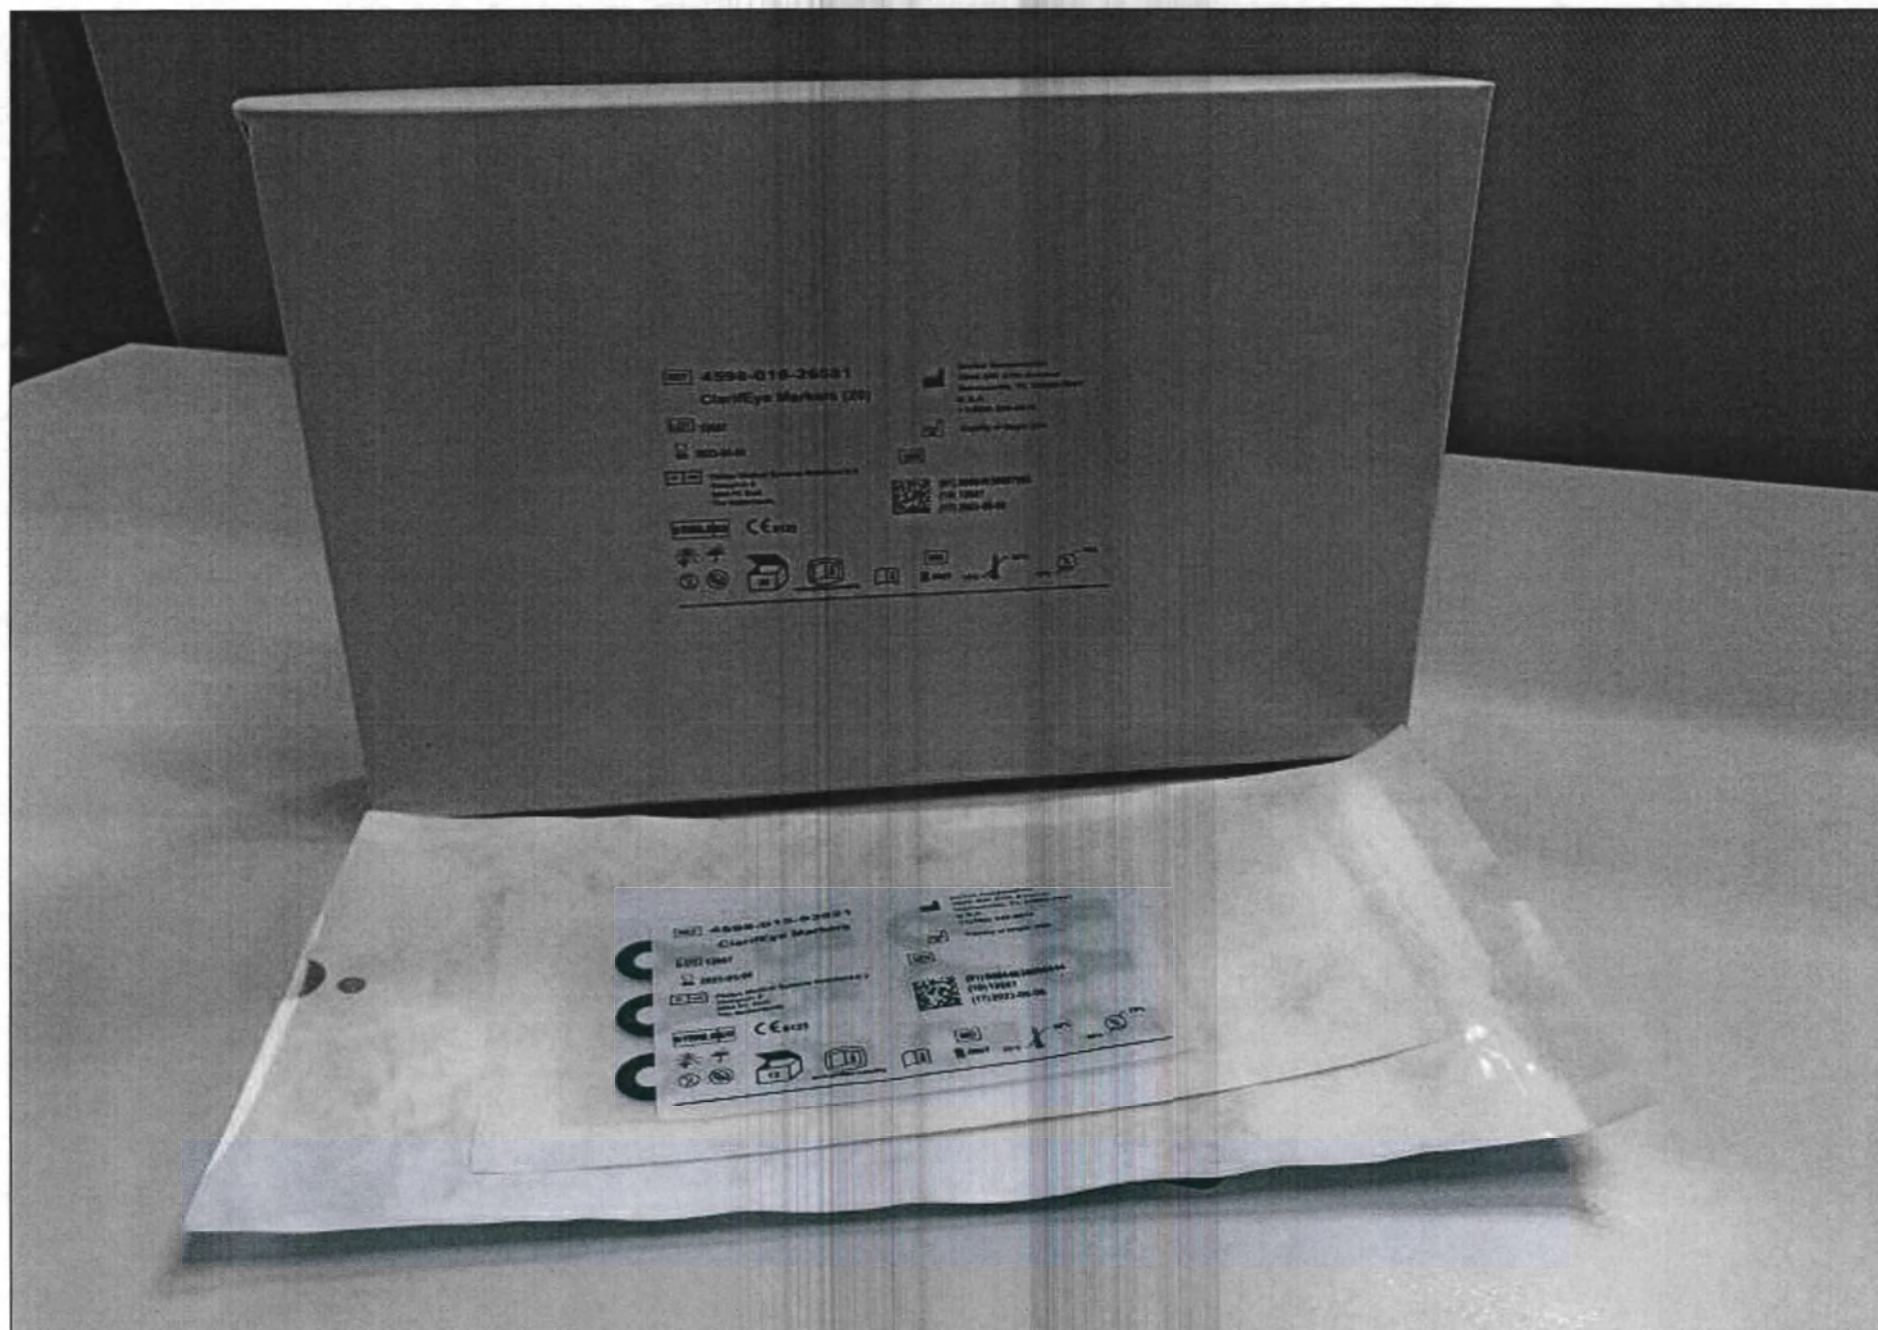


22.4.6. Маркеры кожные оптические стерильные одноразовые ClarifEye Marker, 240 шт./уп. (не более 20 уп.).

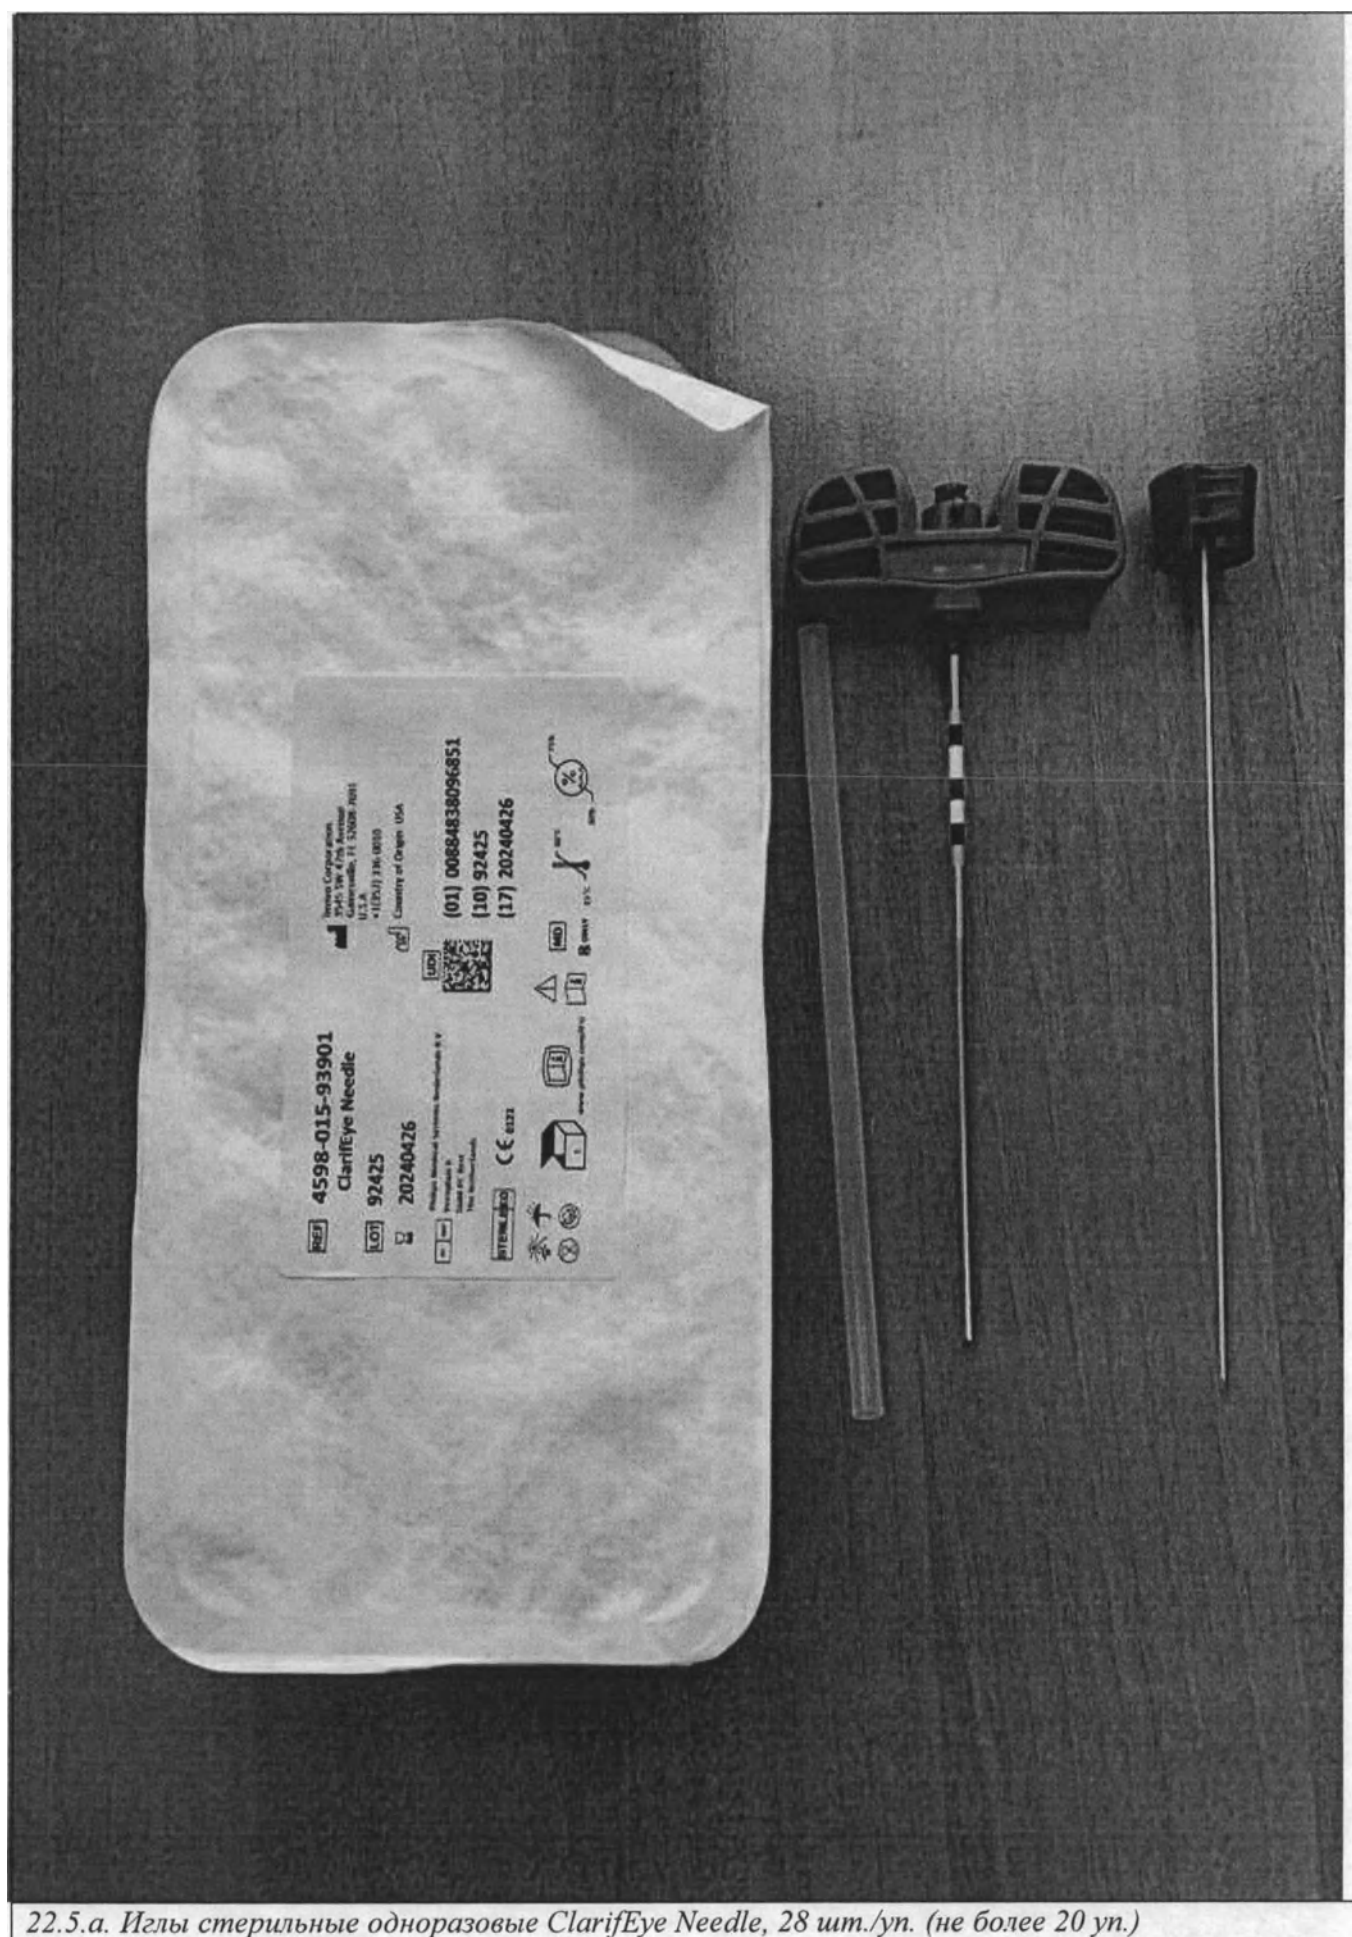

22.5.a. Иглы стерильные одноразовые ClarifEye Needle, 28 шт./уп. (не более 20 уп.)

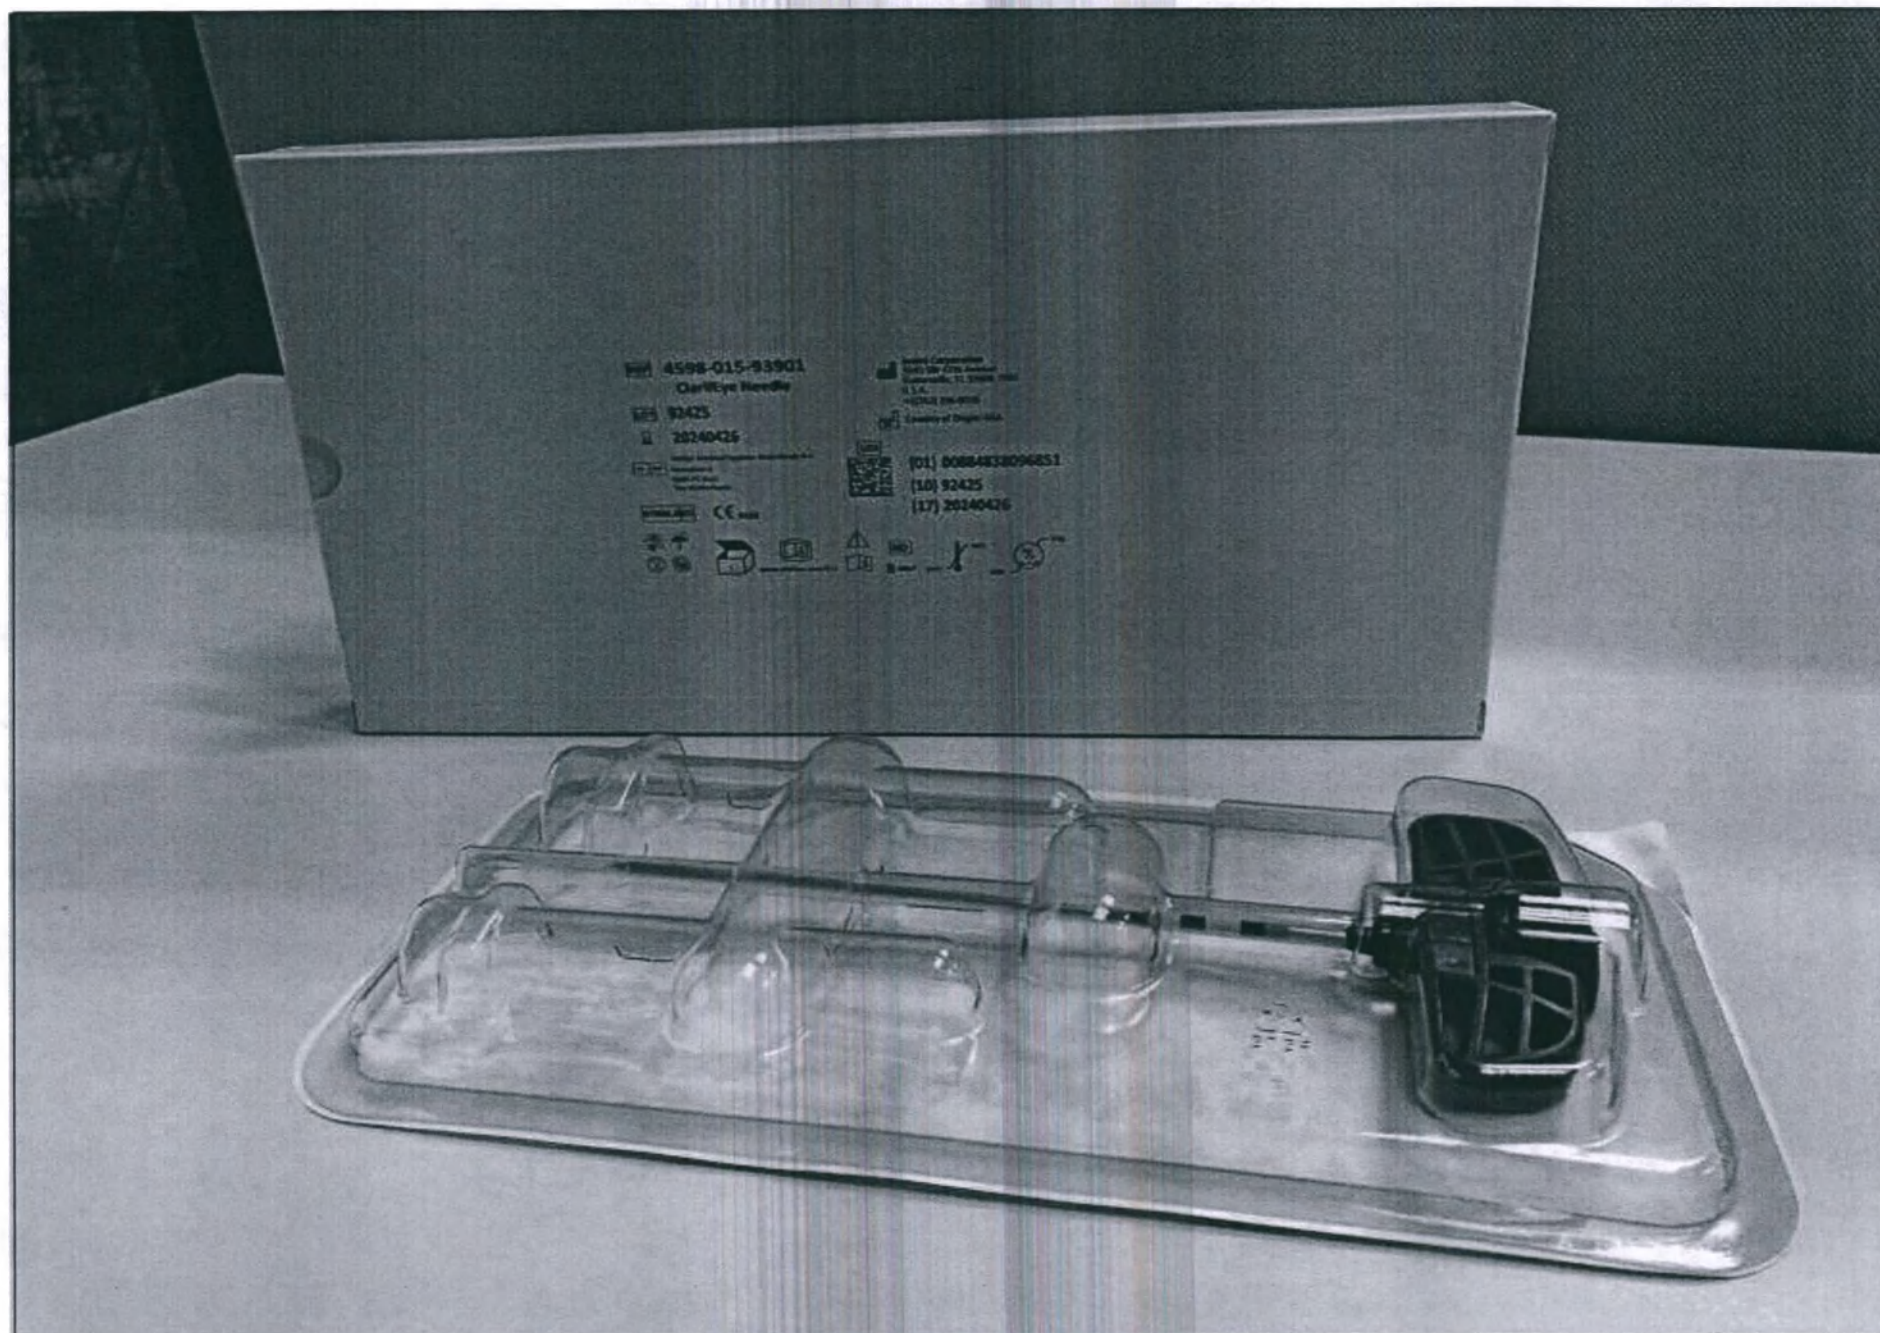

22.5.6. Иглы стерильные одноразовые ClarifEye Needle, 28 шт./уп. (не более 20 уп.)

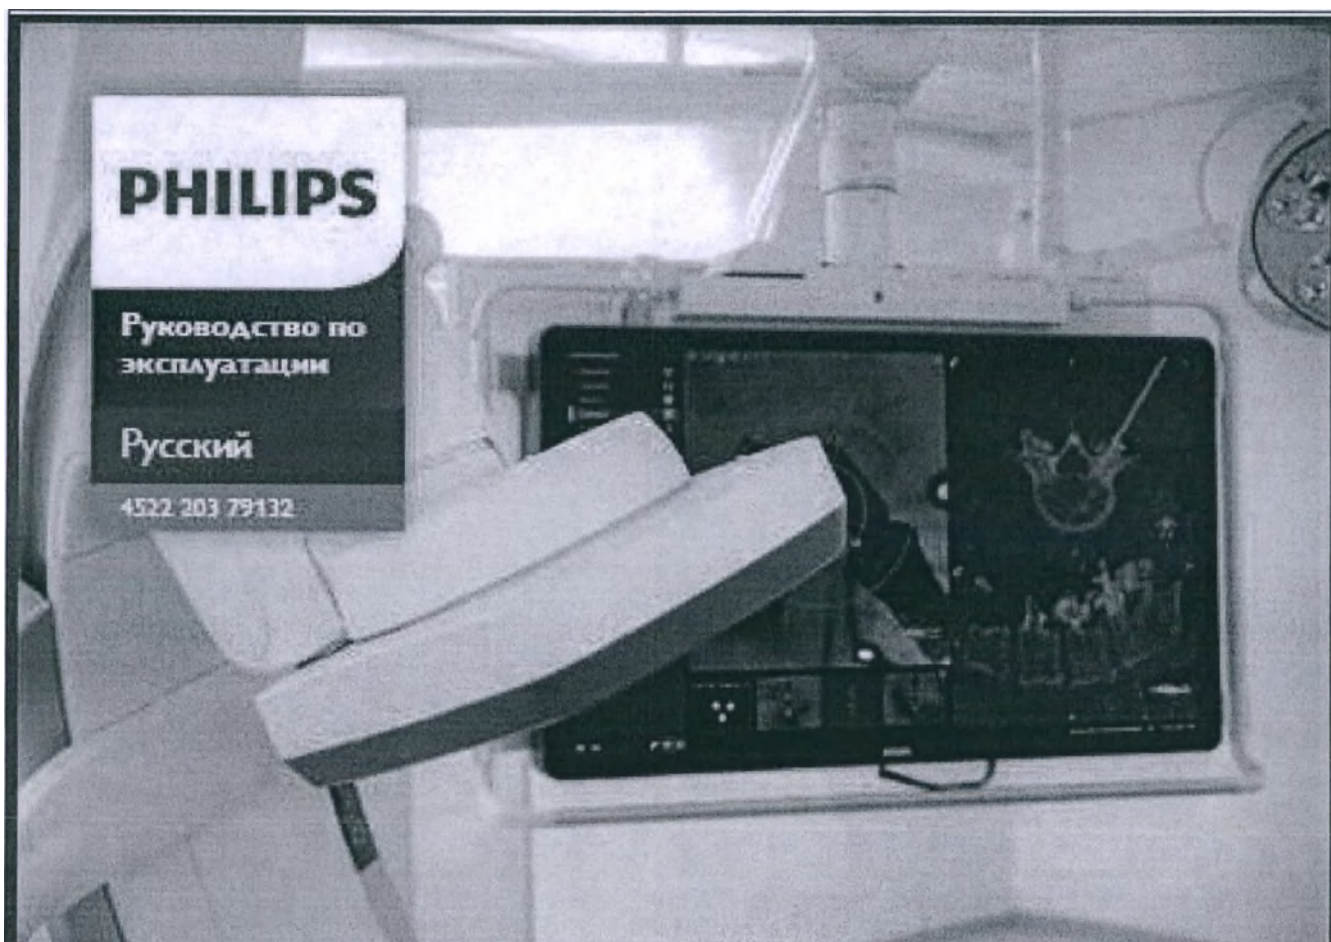

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский


4522 203 79132

Philips ClarifEye

Версия 1.0

22.6. Руководство по эксплуатации ClarifEye на бумажном носителе.


Система ангиографическая Azurion 7 M20 (вариант 3):

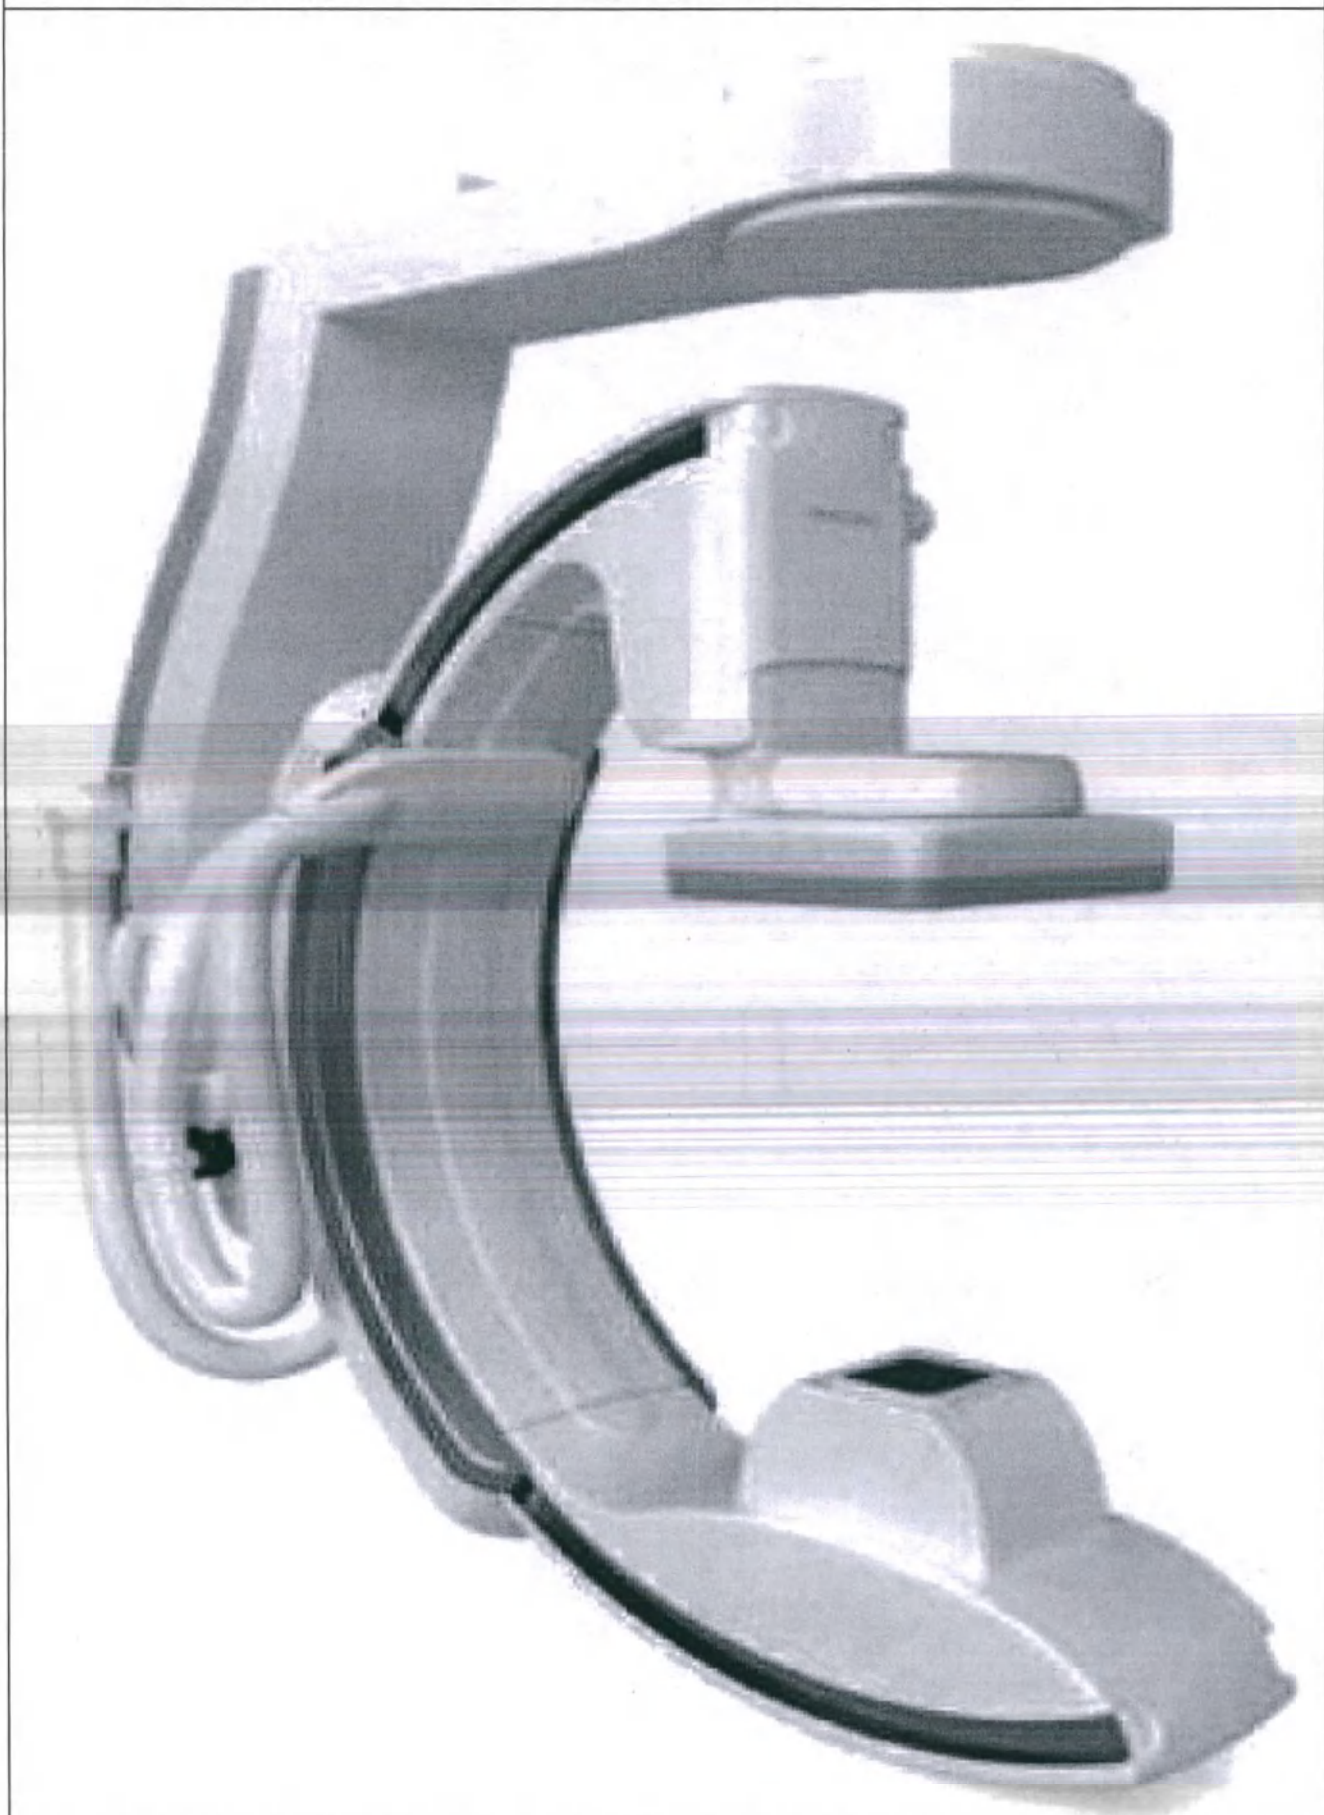

1. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C20.




1.6. Модуль C-дуги в составе: штатив с потолочным креплением C-дуги(с опцией FlexArm); C-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C20.

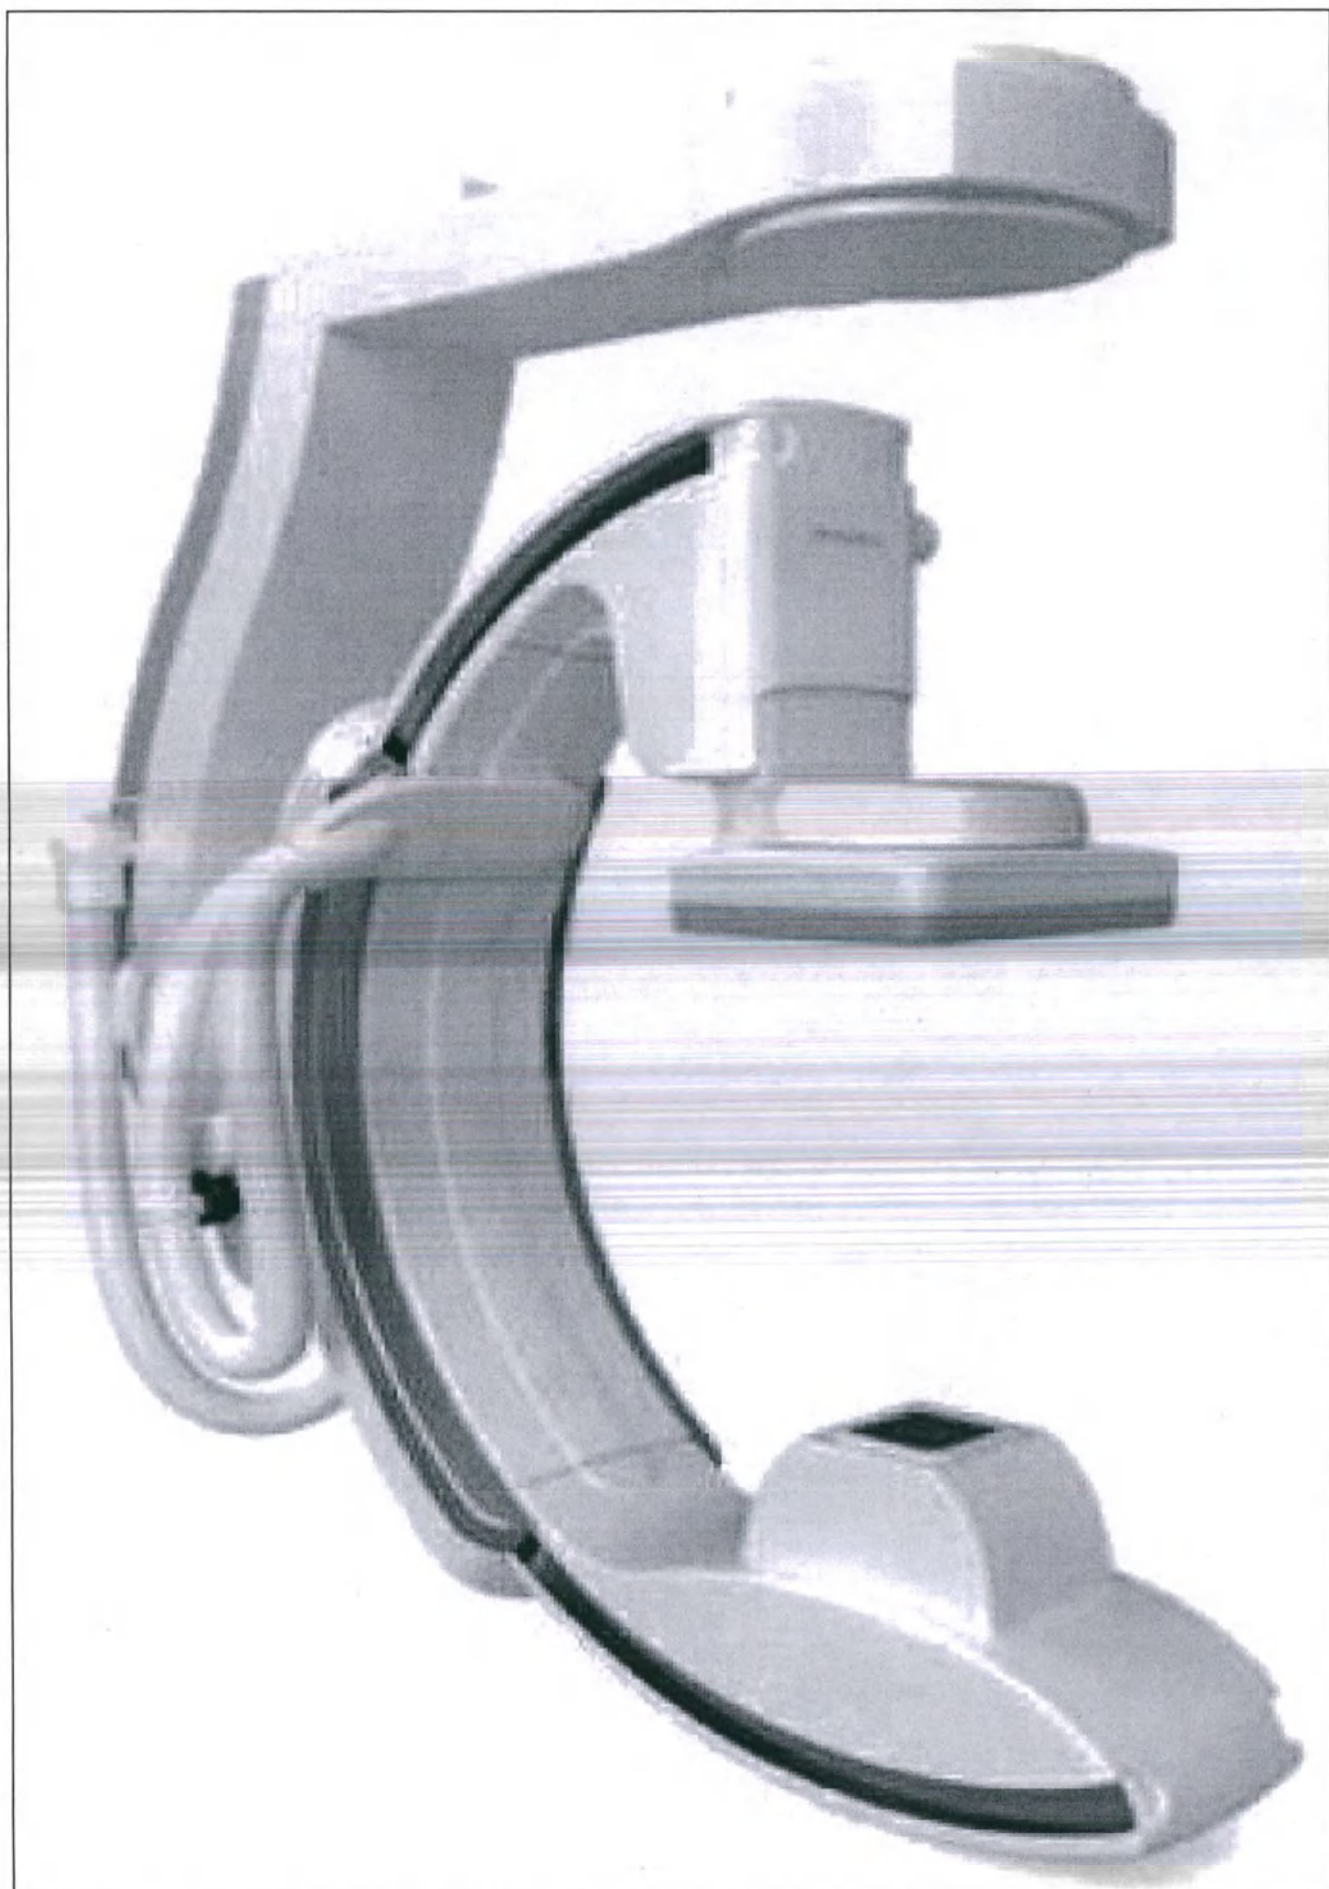


1.в. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.




*1.г. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга (с опцией **FlexArm**); рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C20.*

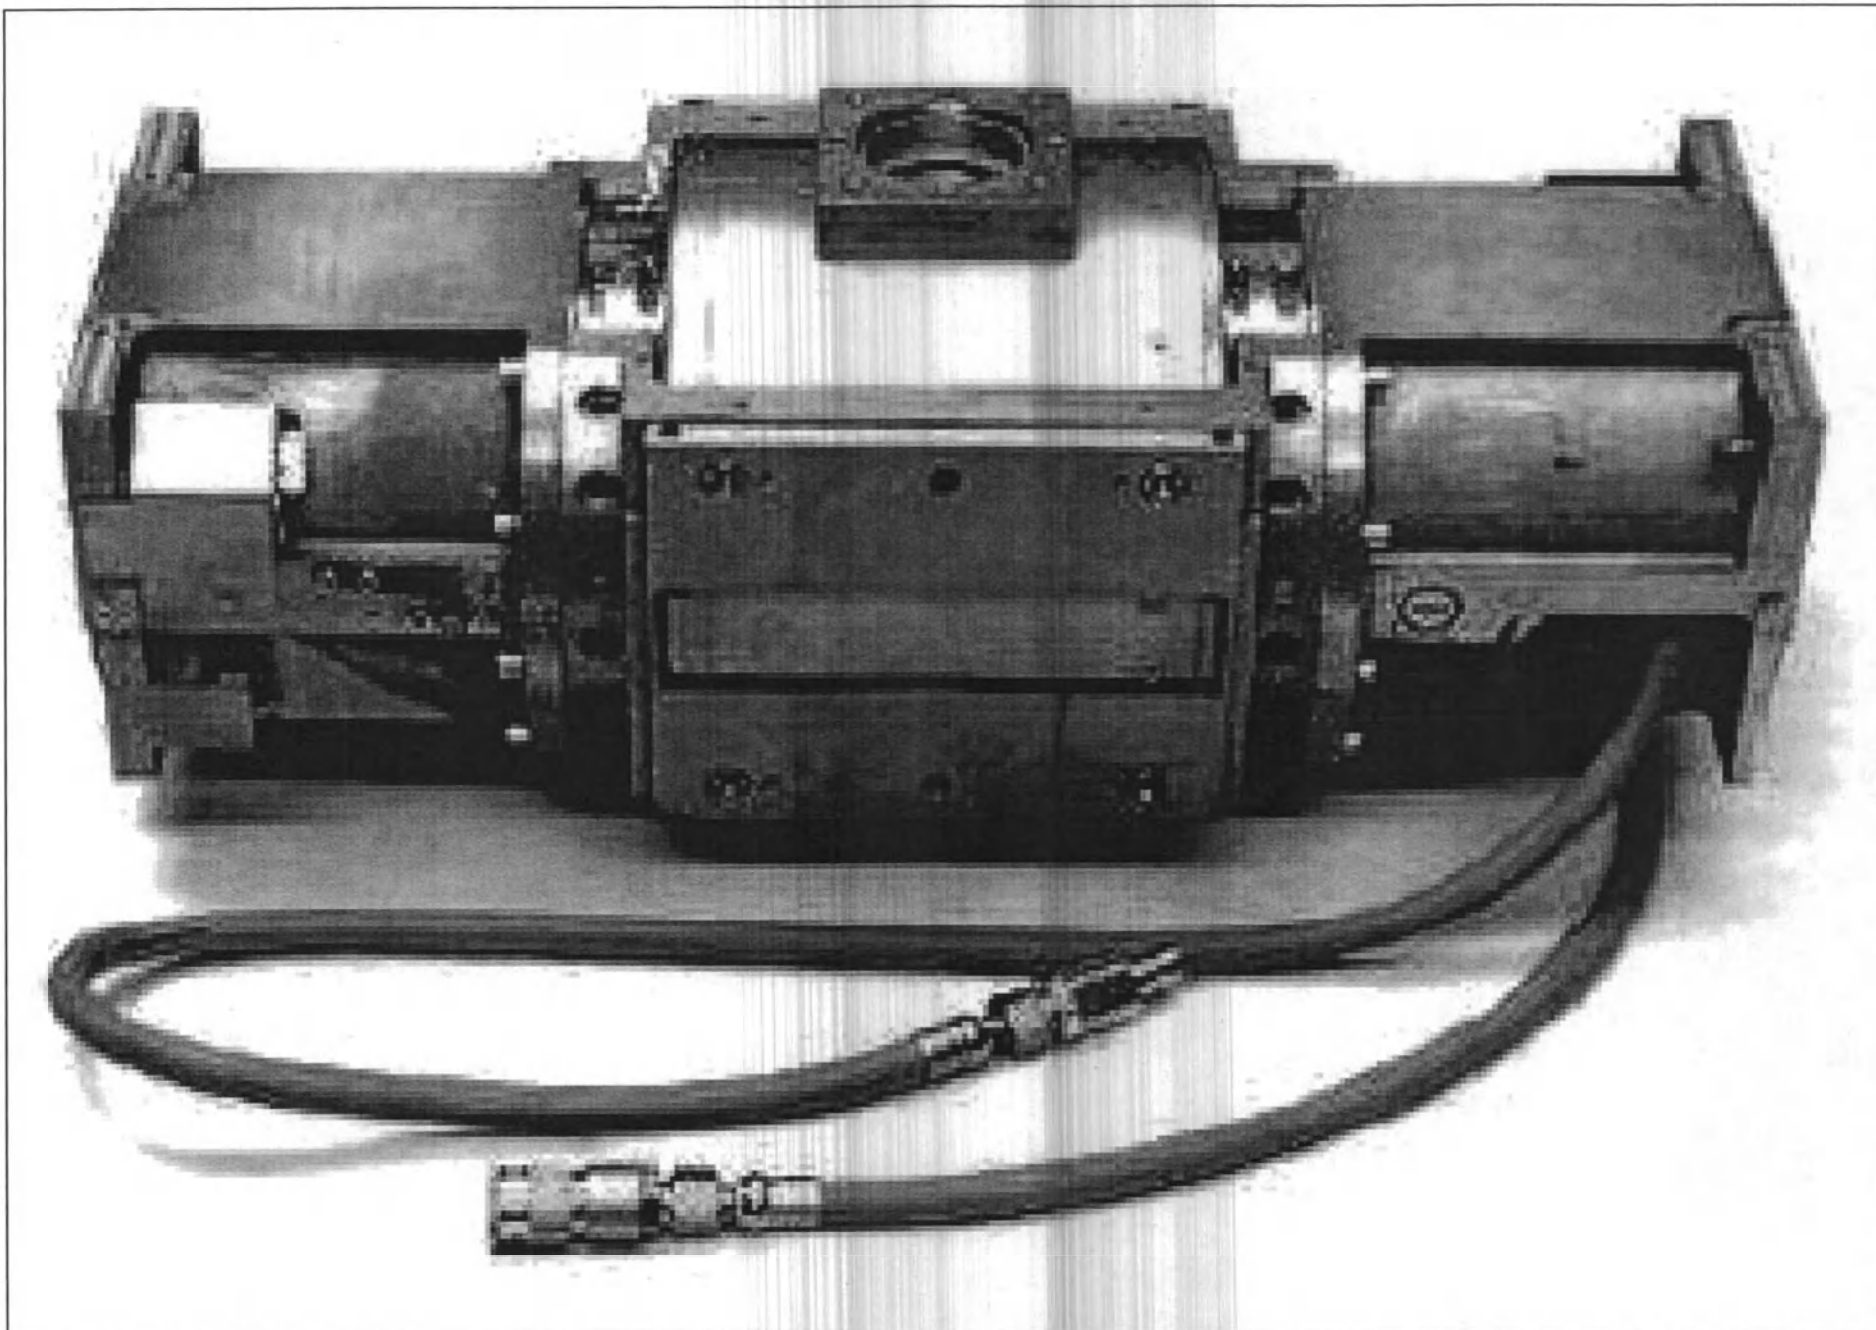


1.д. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

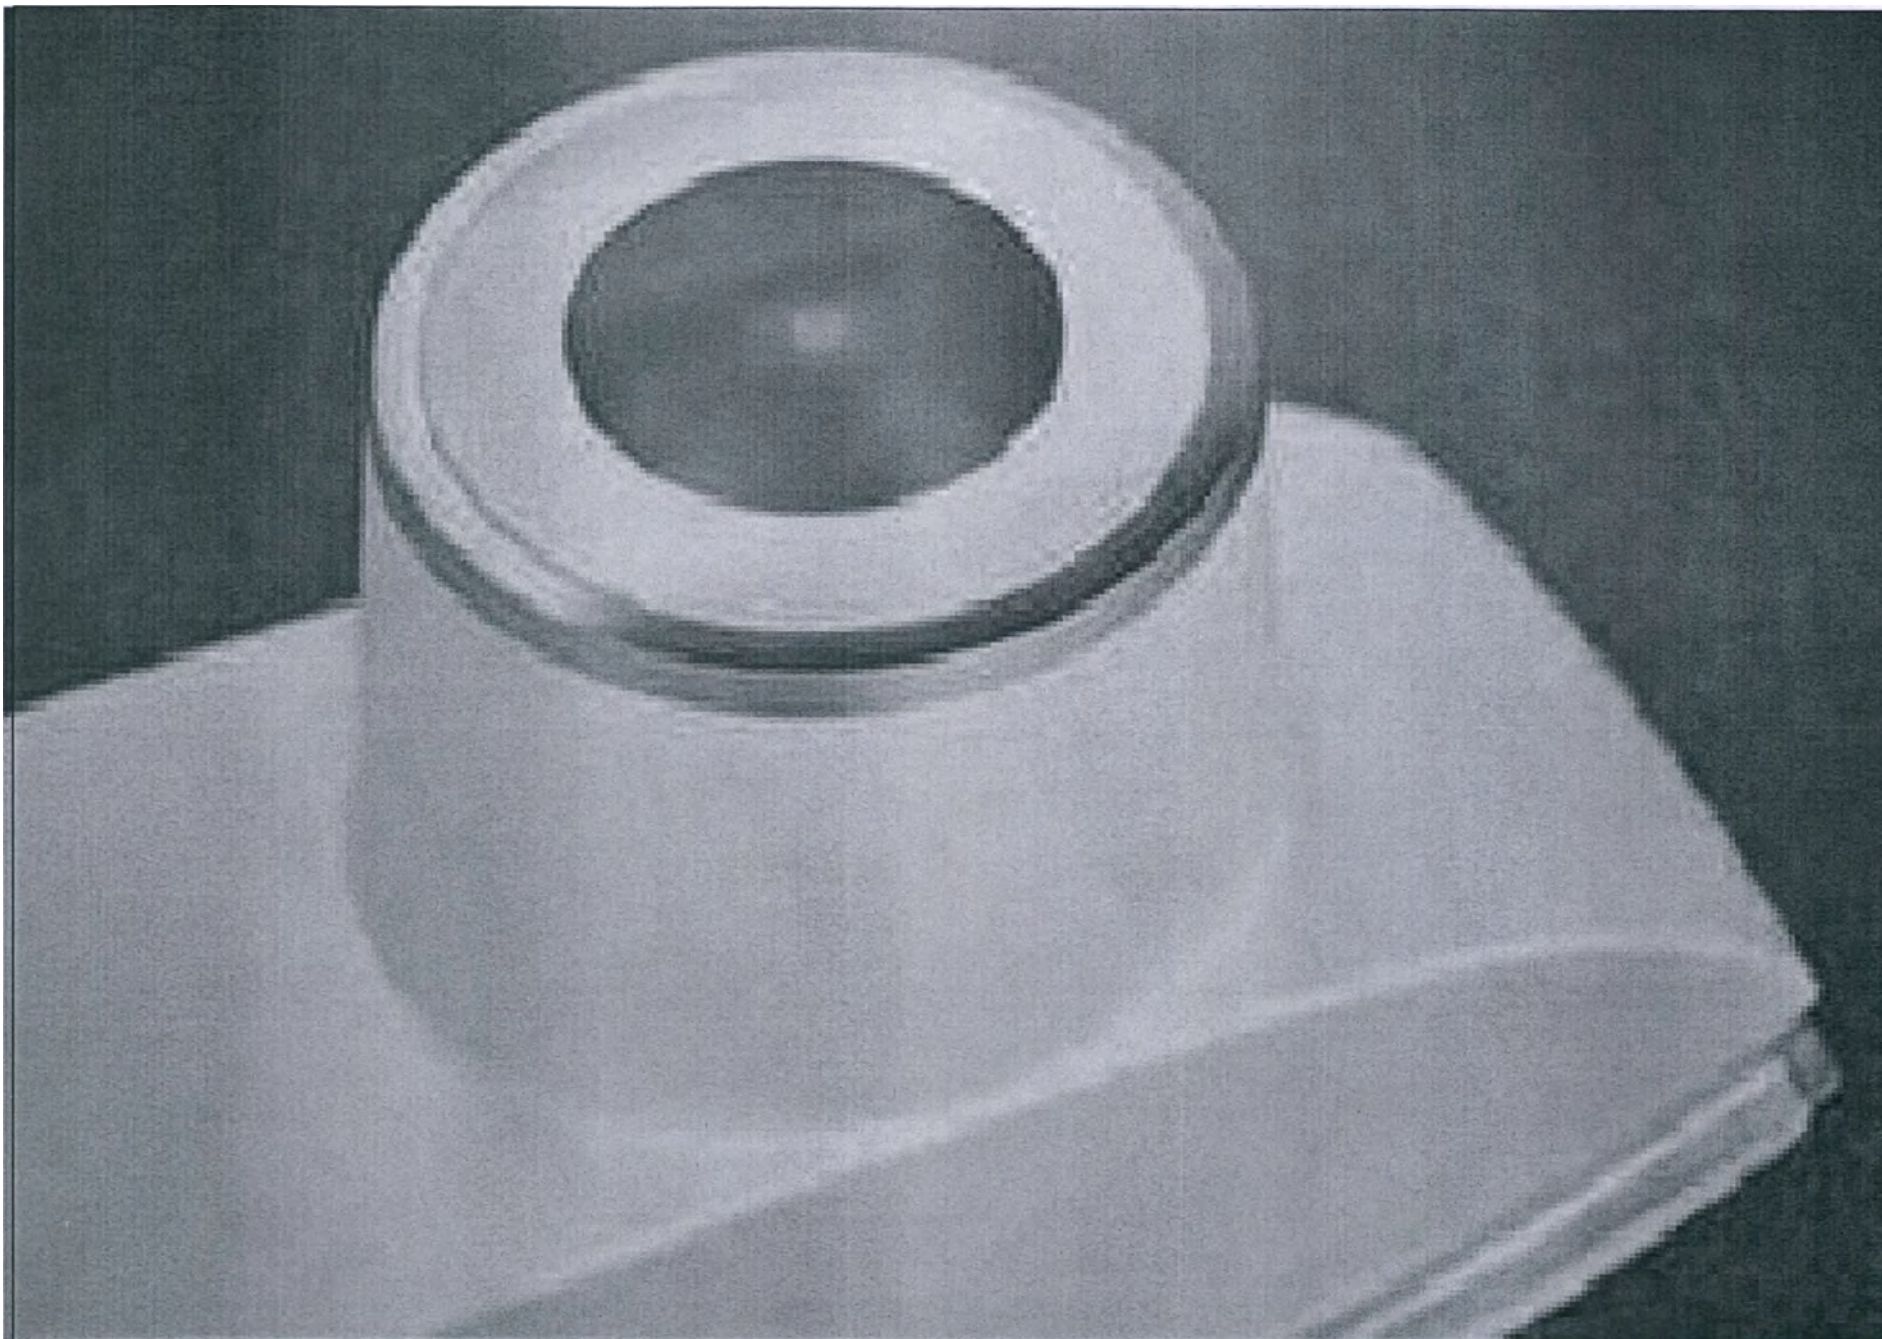


1.е. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

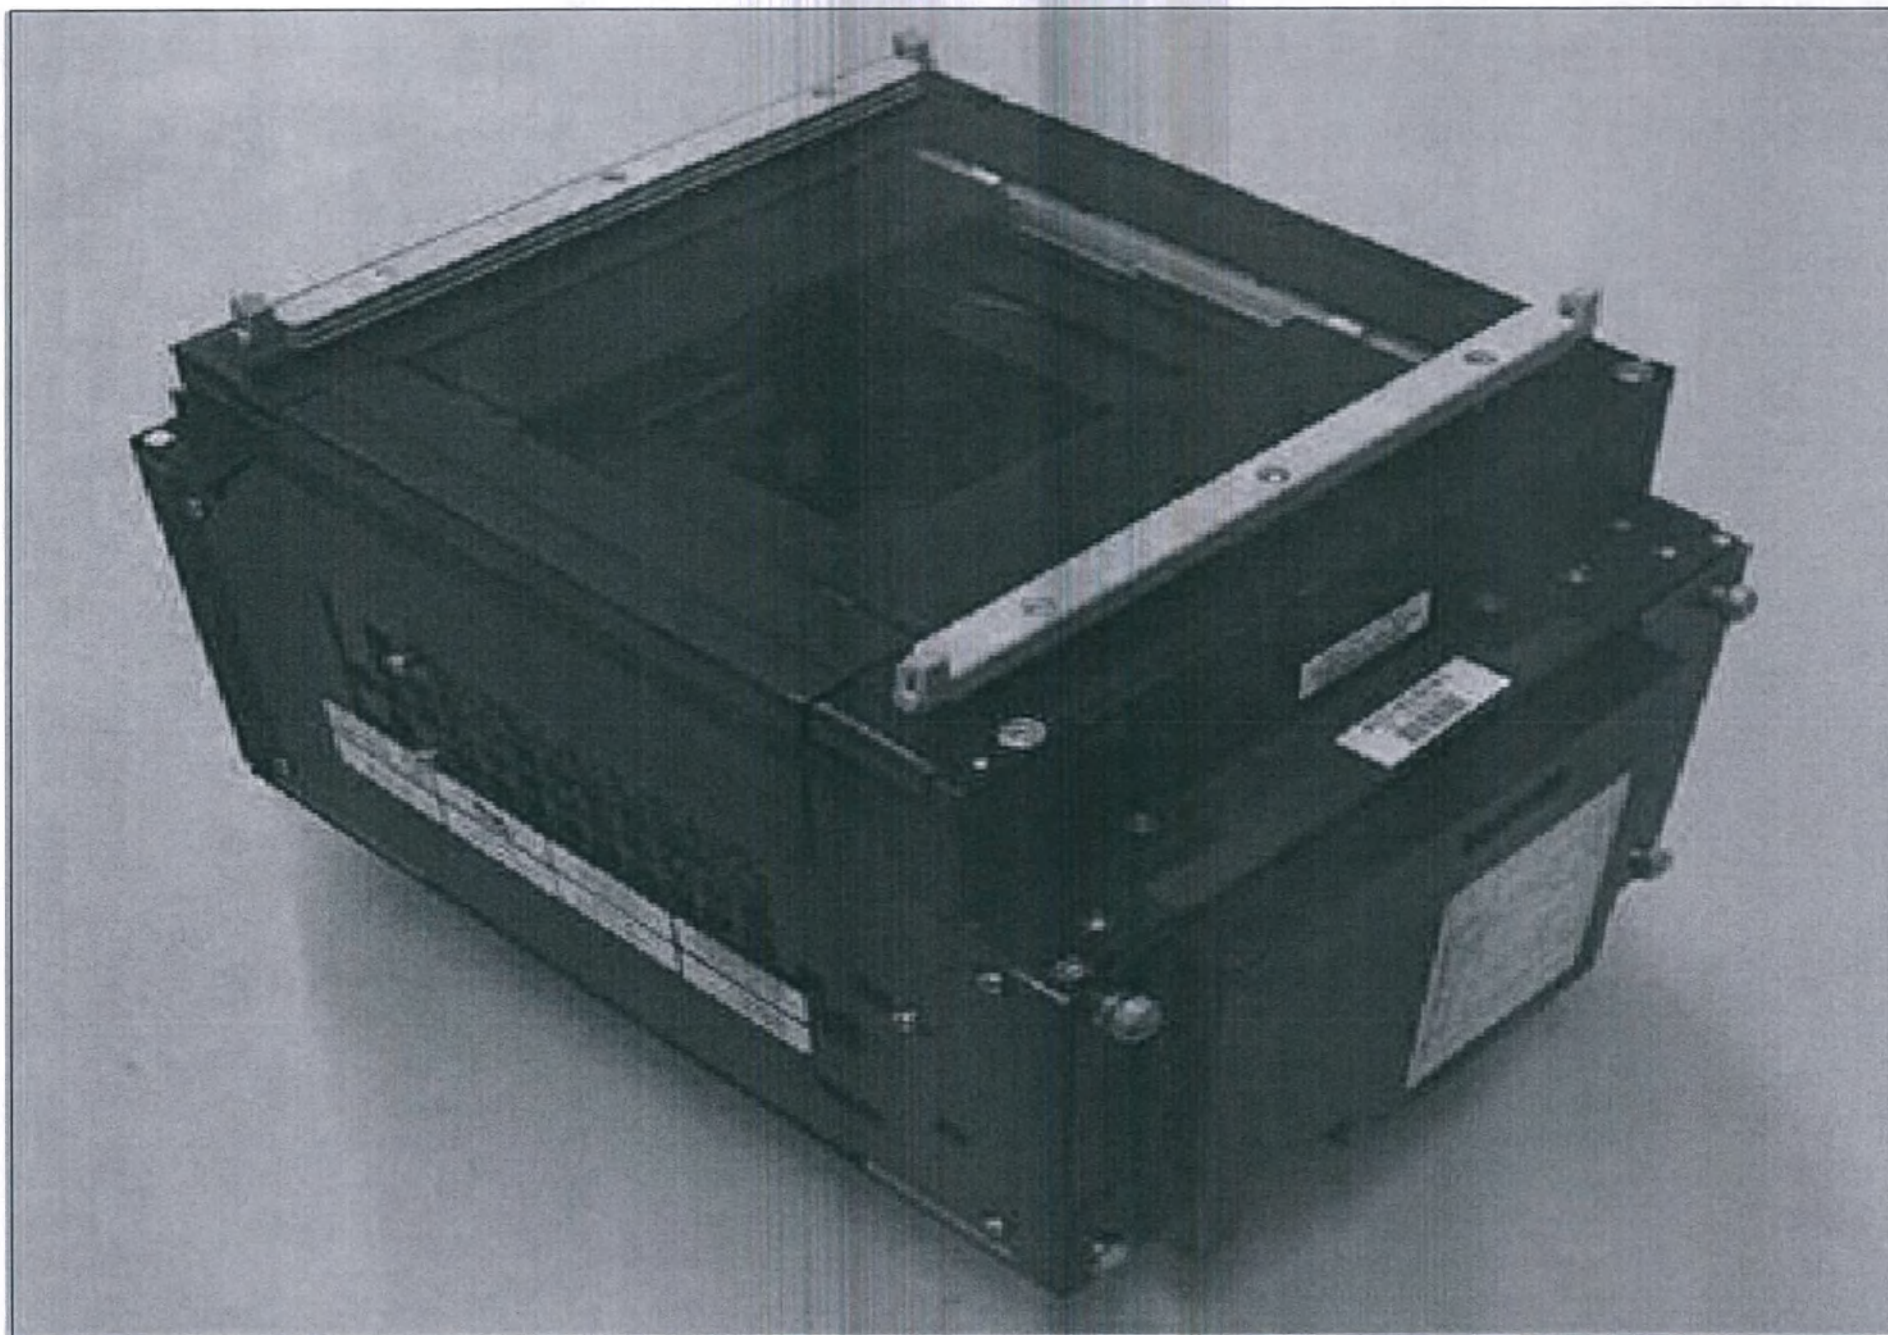


1.ж. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

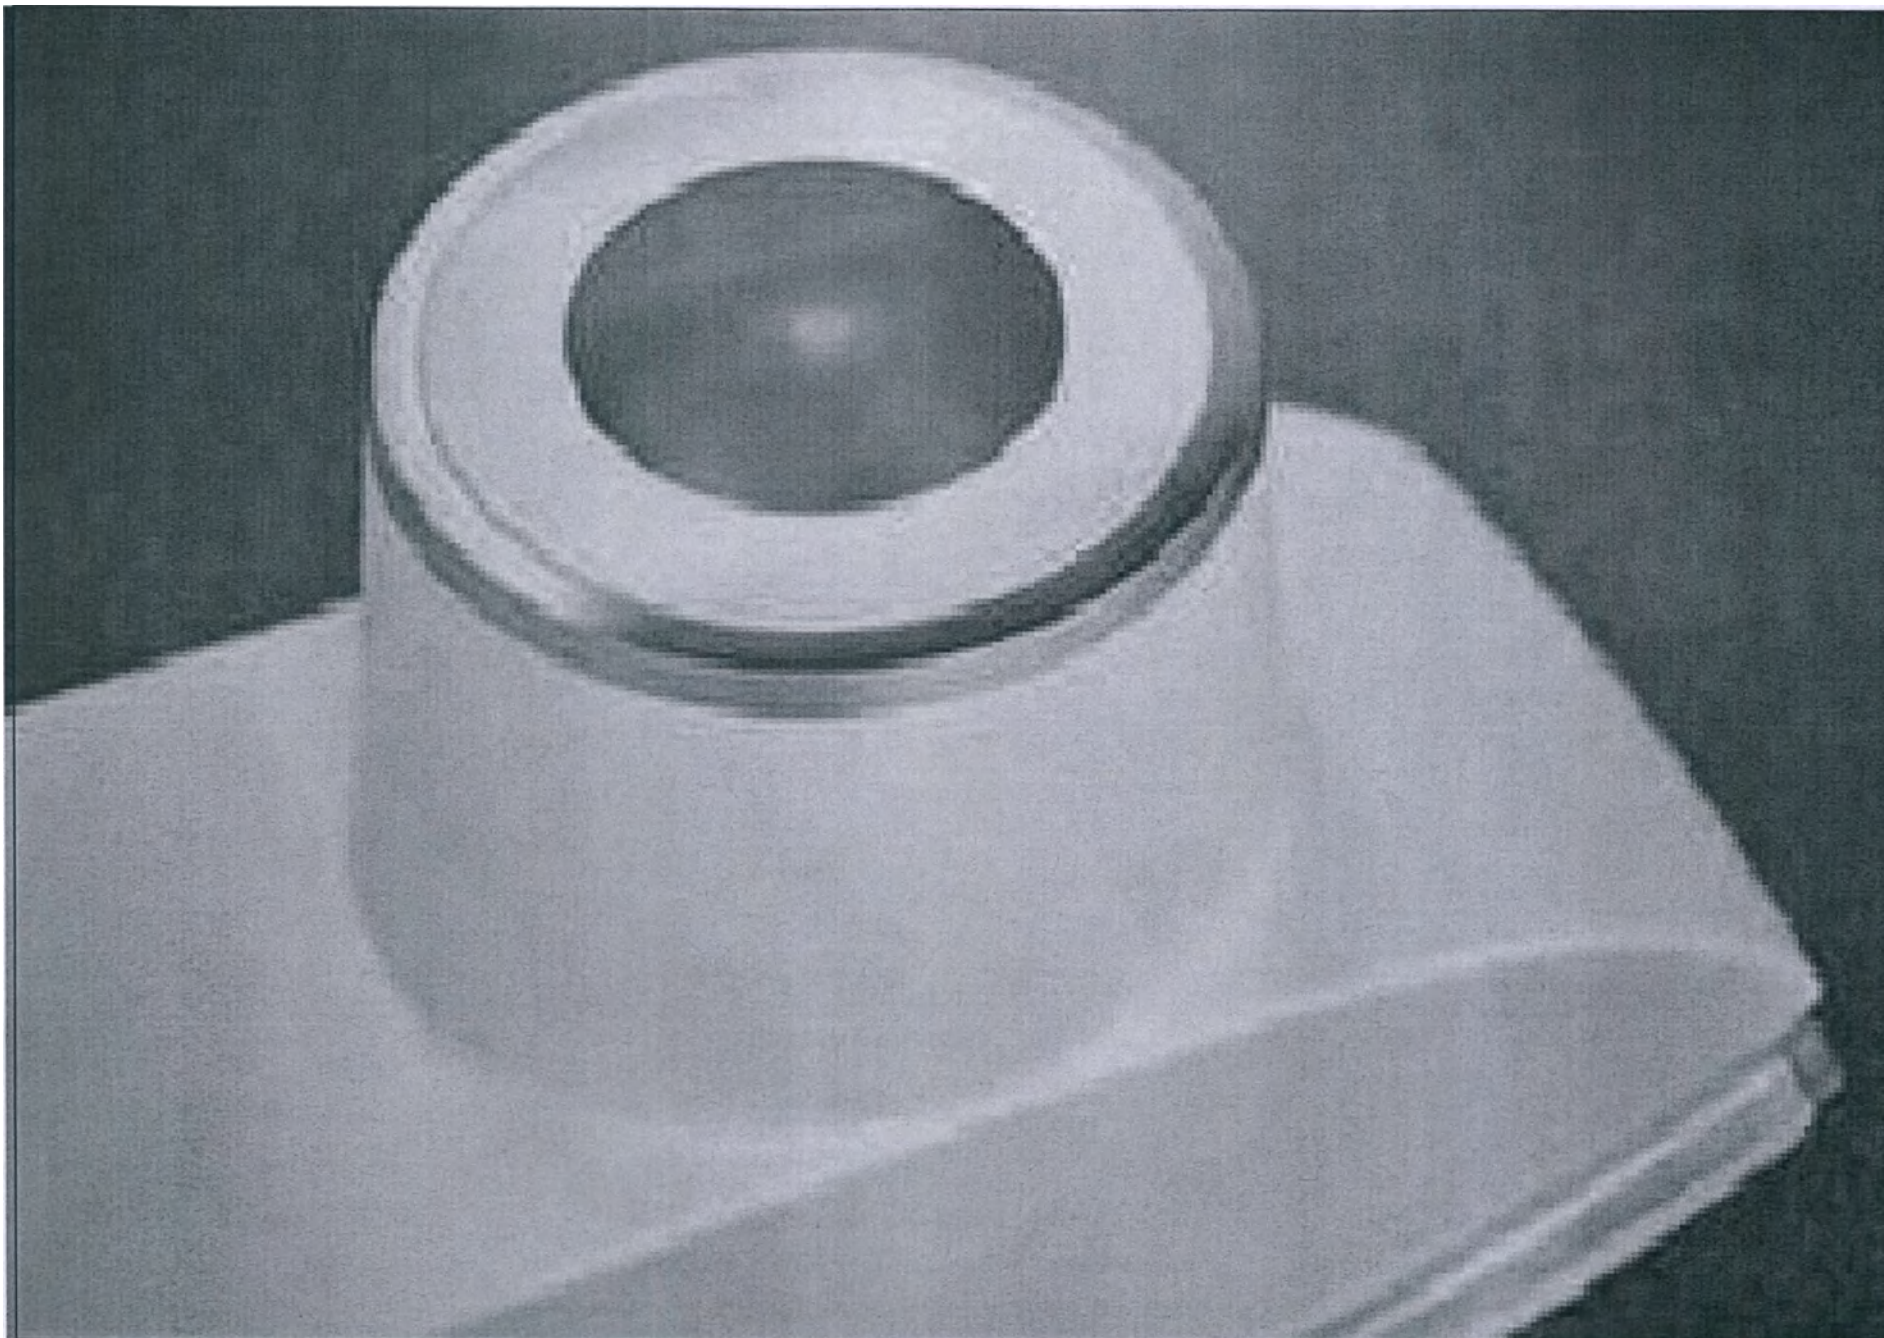


1.3. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

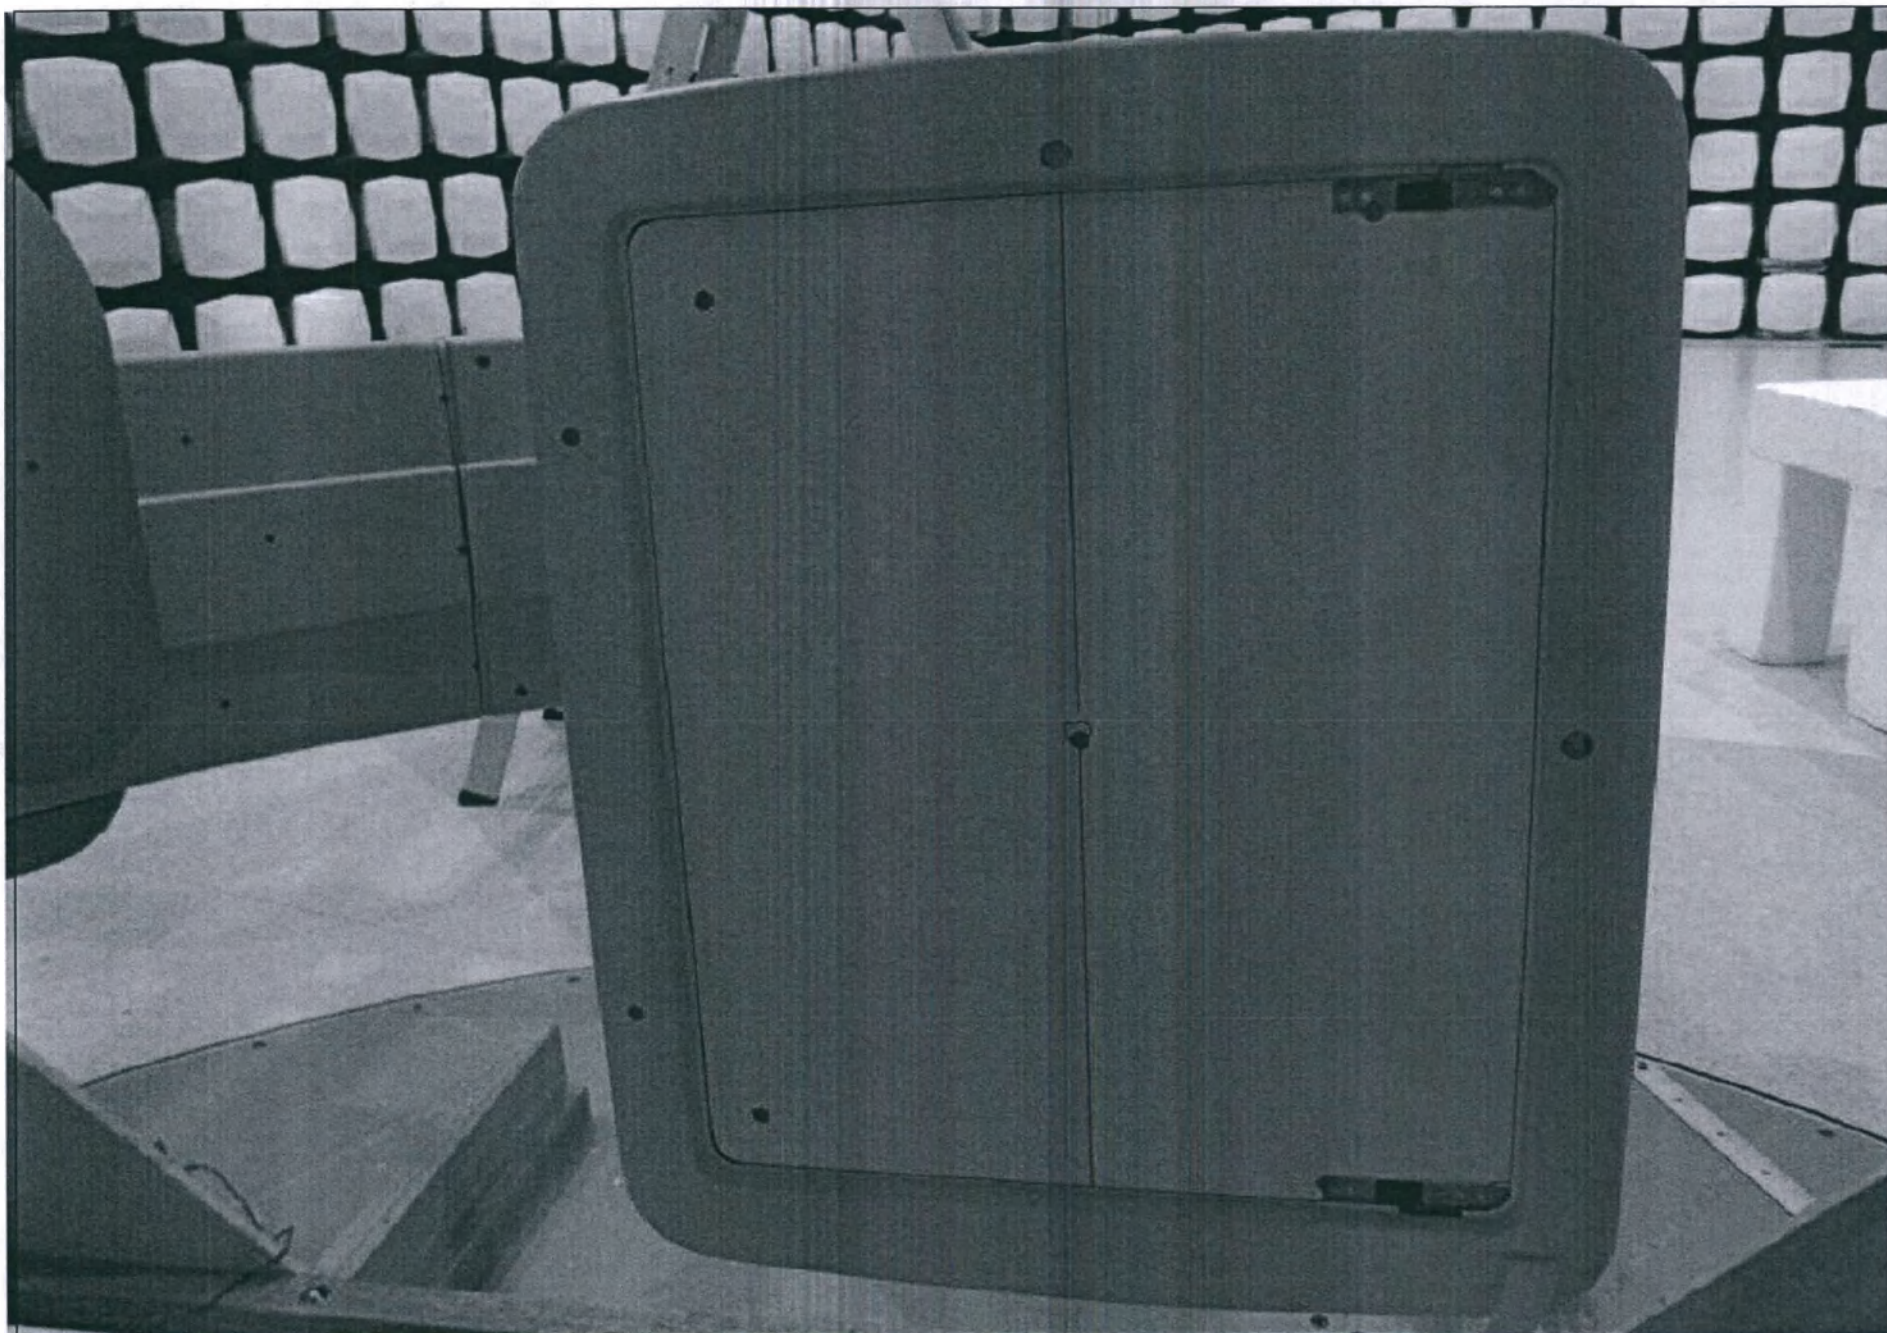


1.и. Модуль С-дуги в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

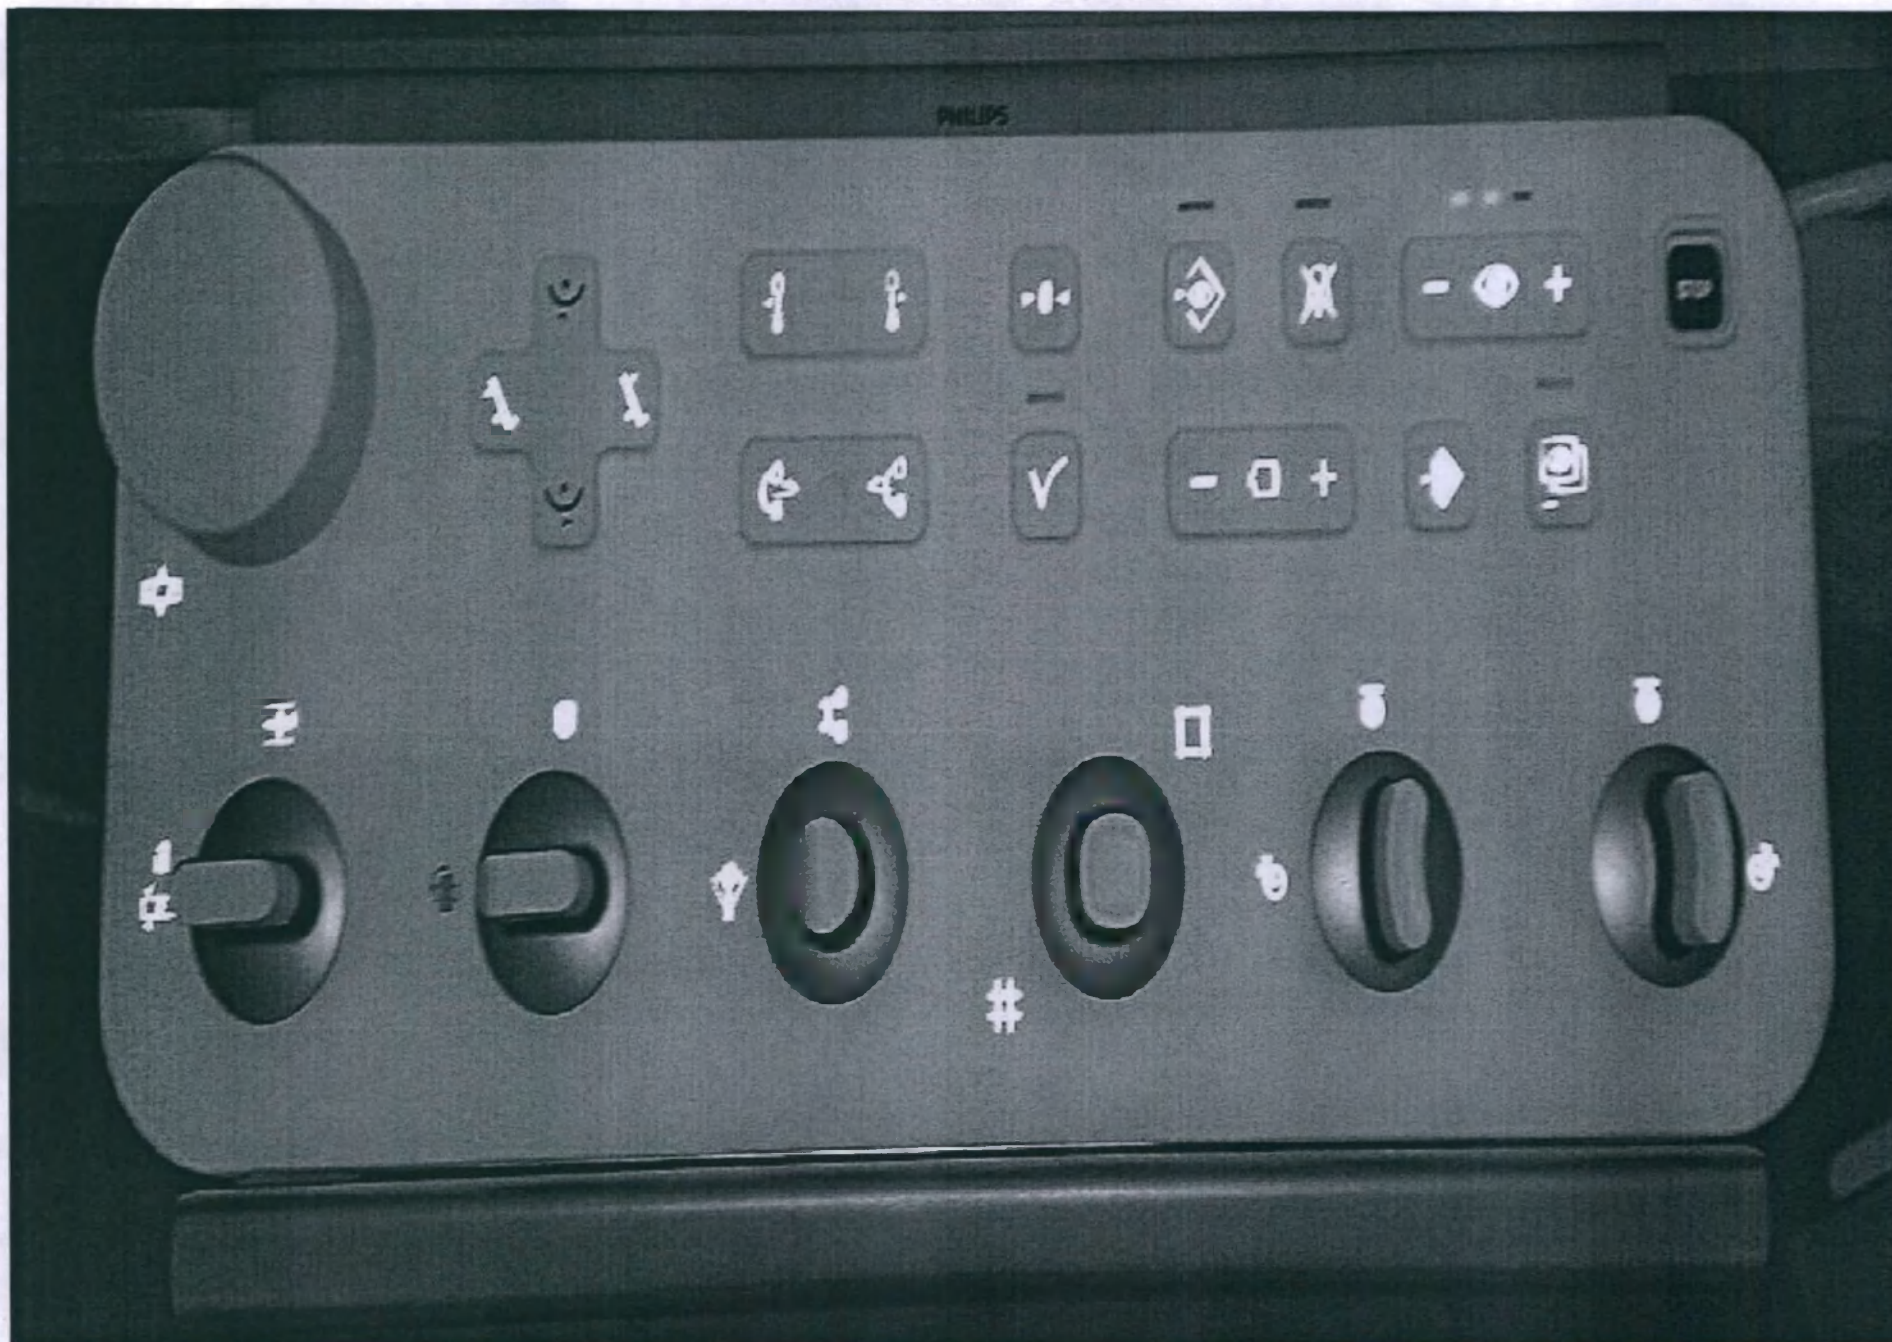


2.а. Модуль управления, не более 4 шт.

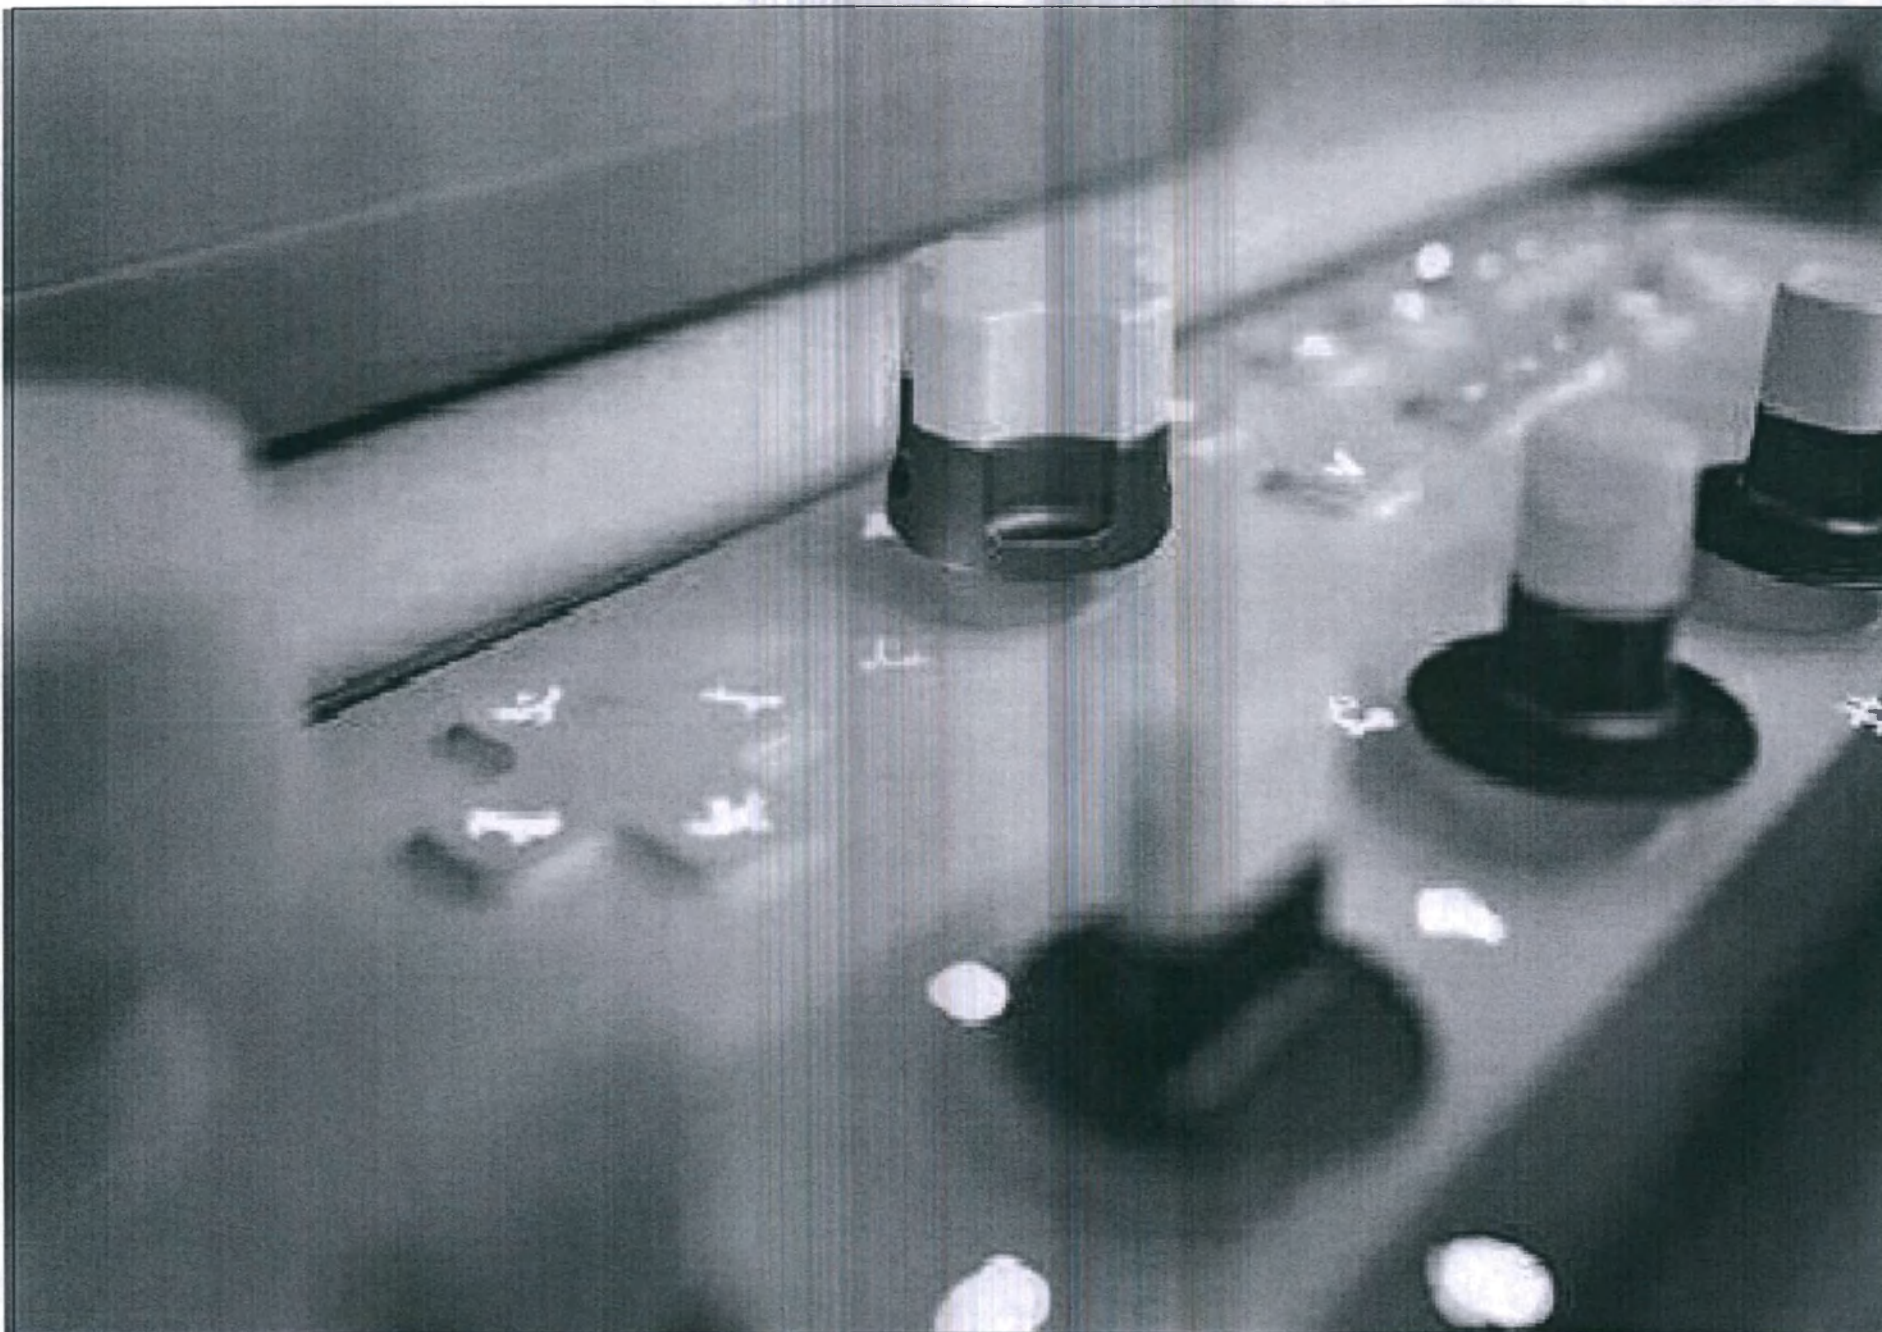

2.б. Модуль управления, не более 4 шт. (для С-дуги с опцией FlexArm).

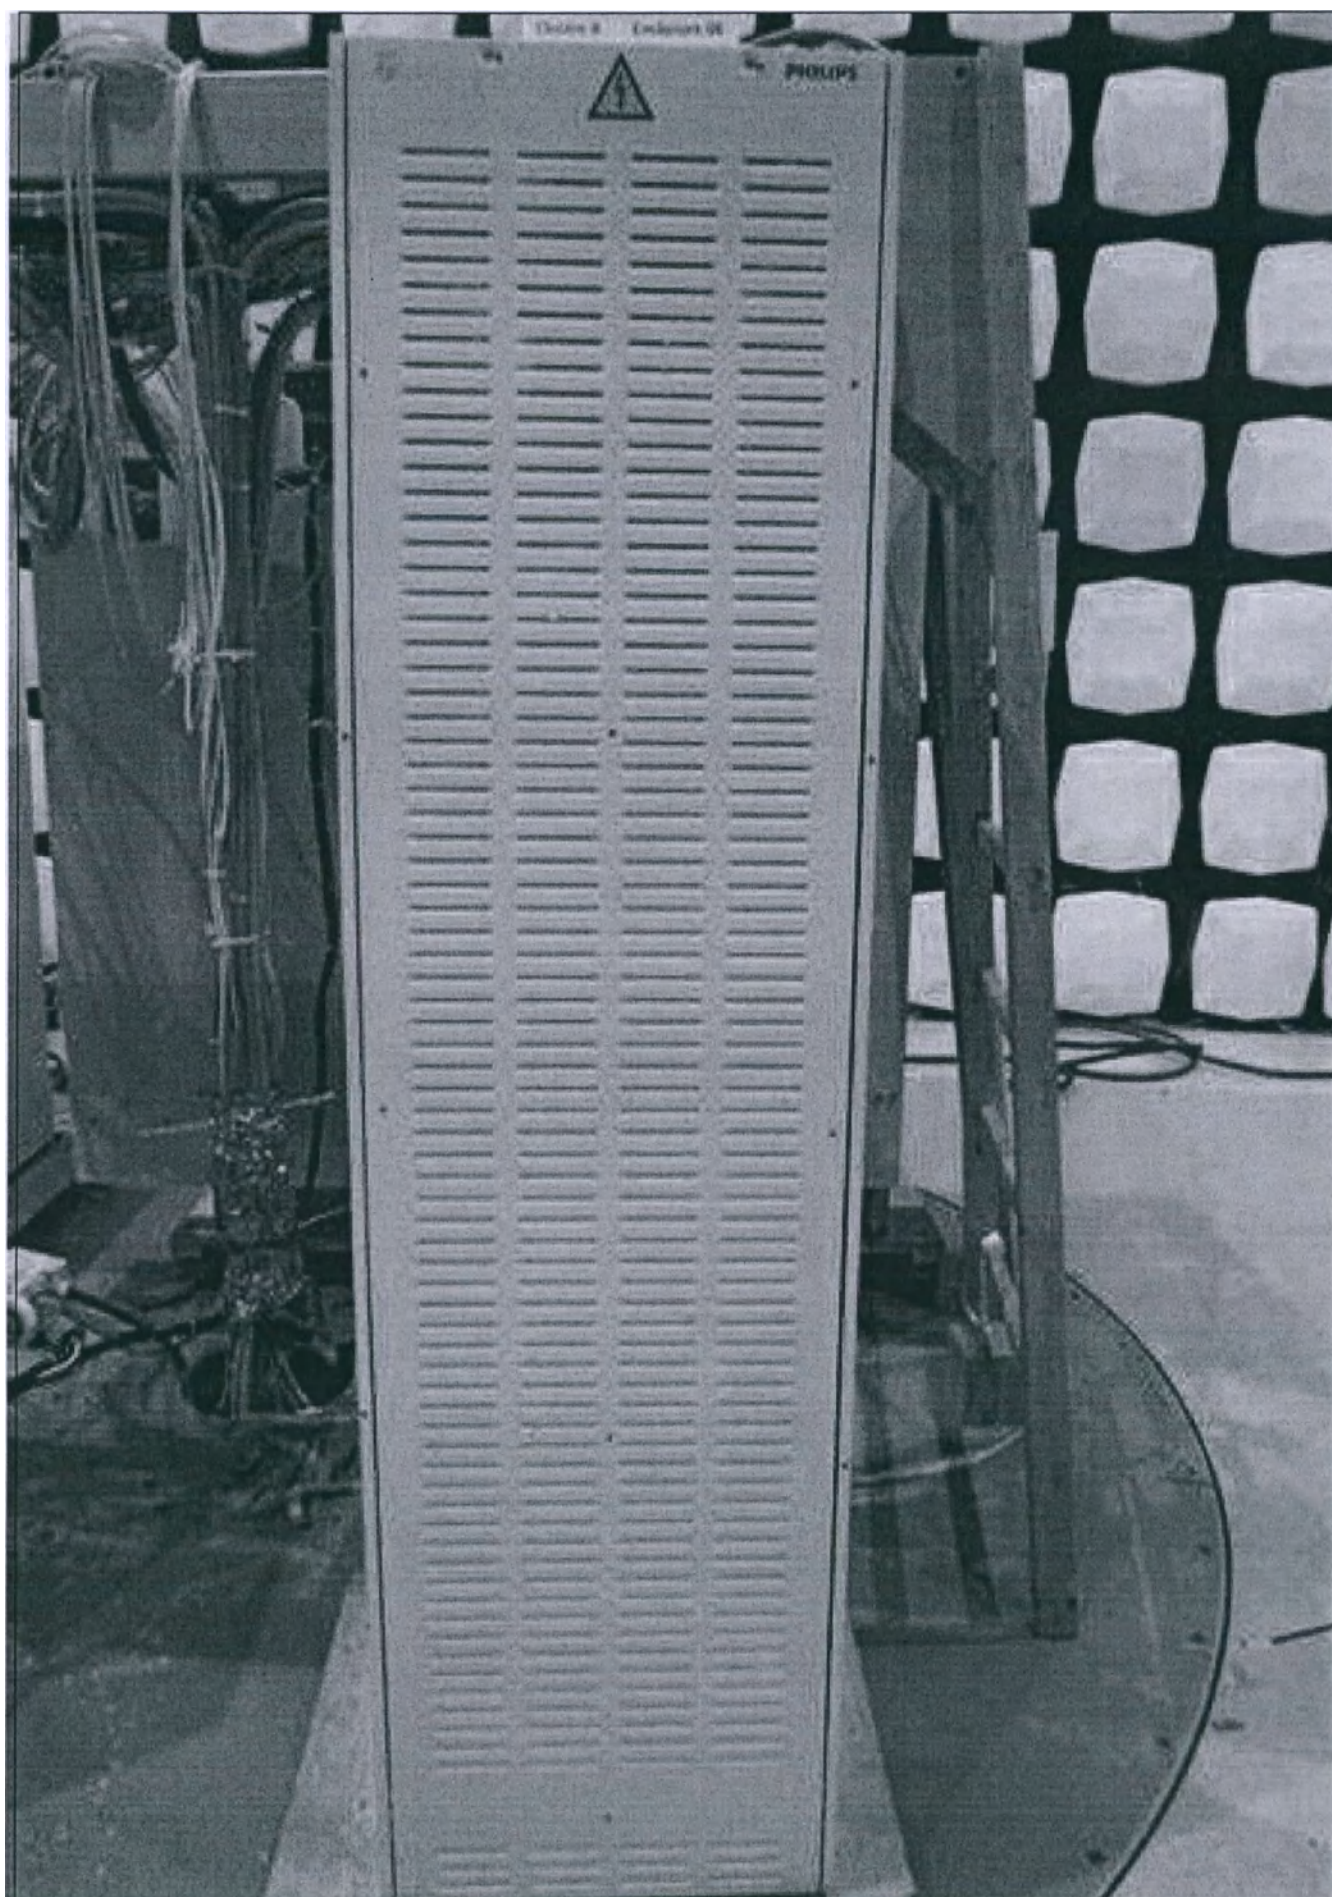



3.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

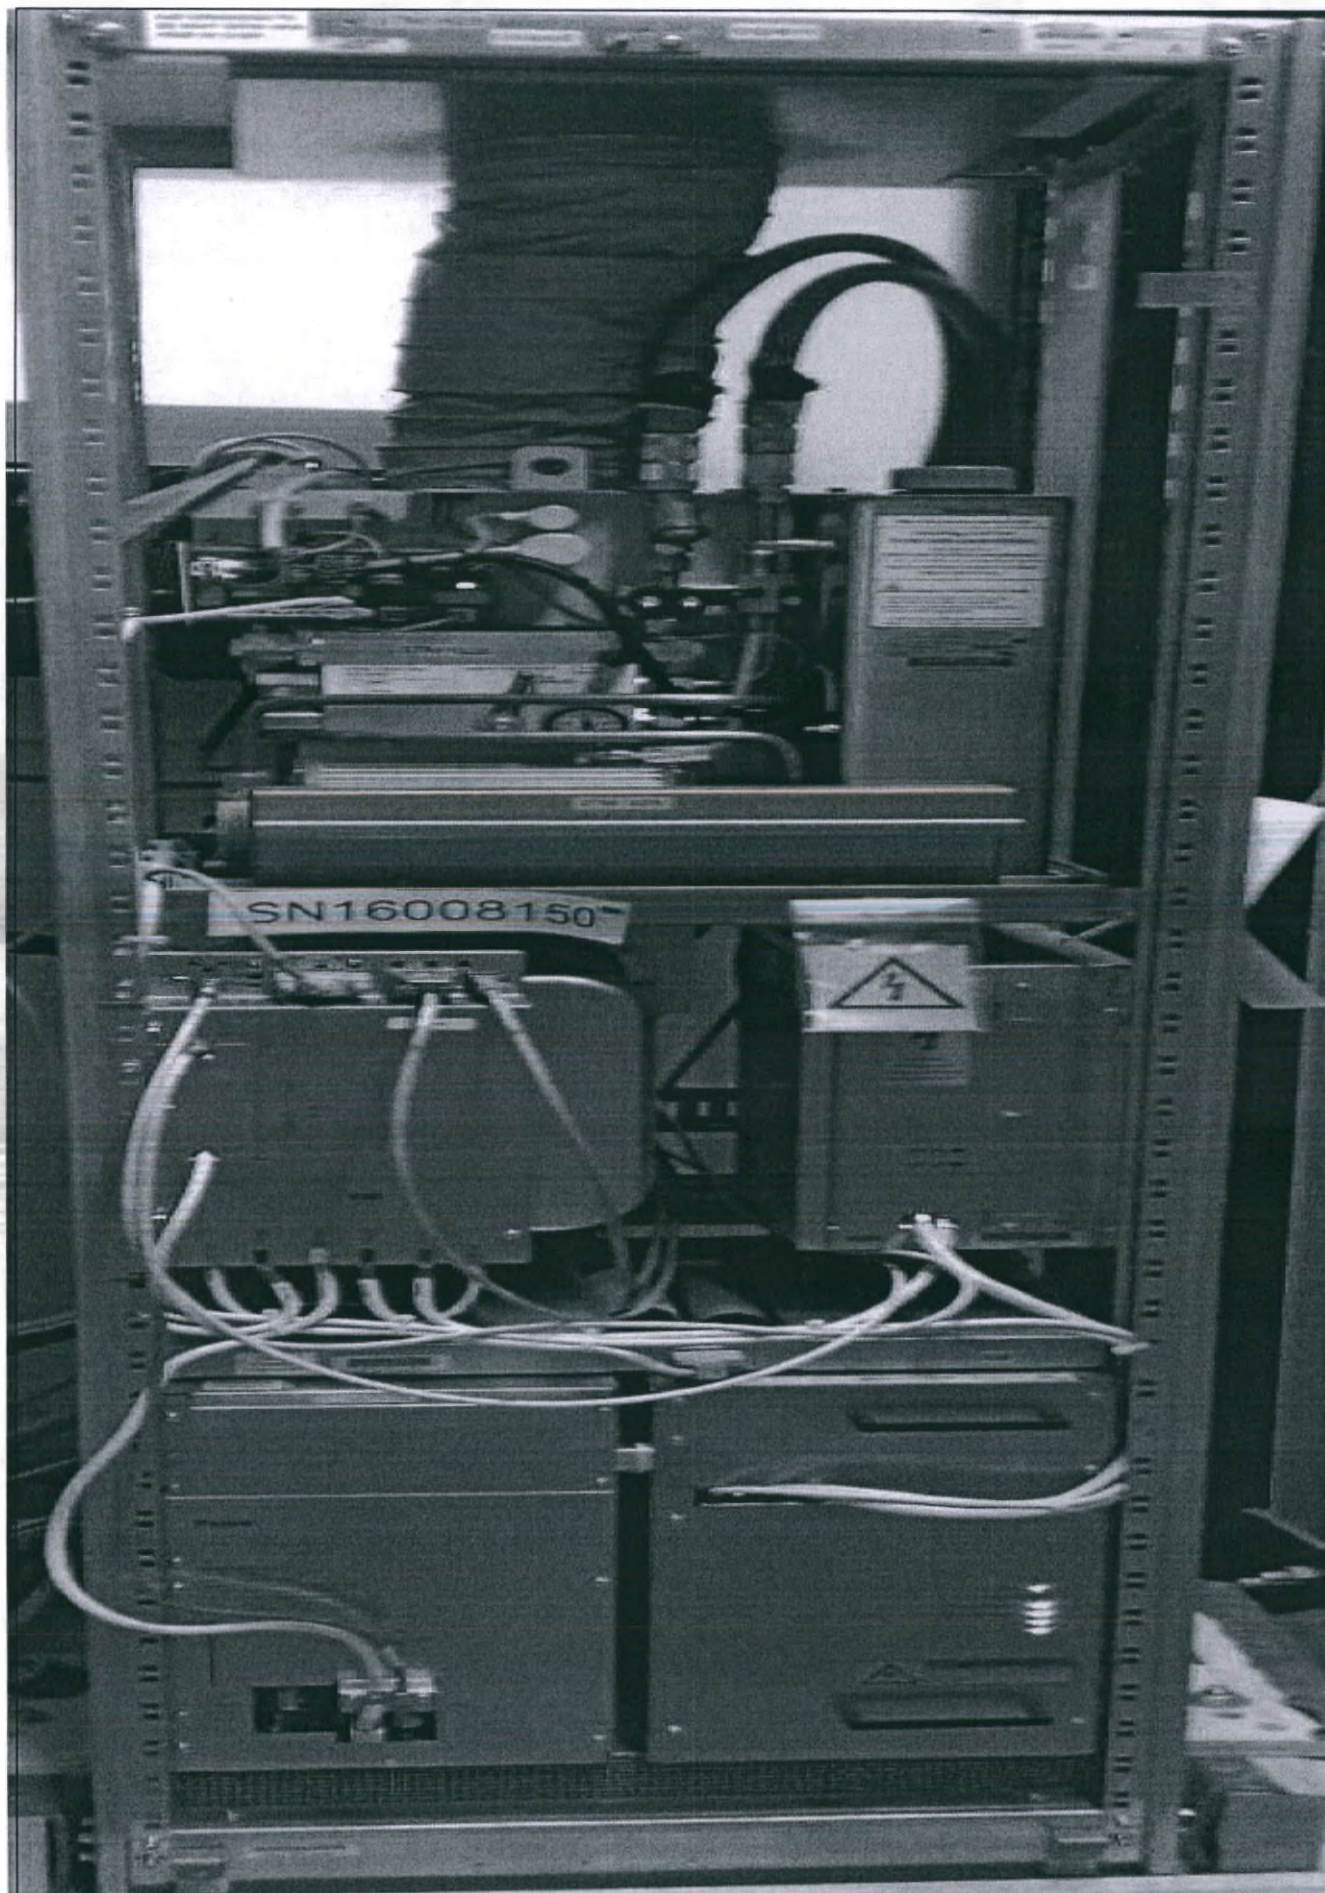


3.б. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

4.а. Шкаф управления.

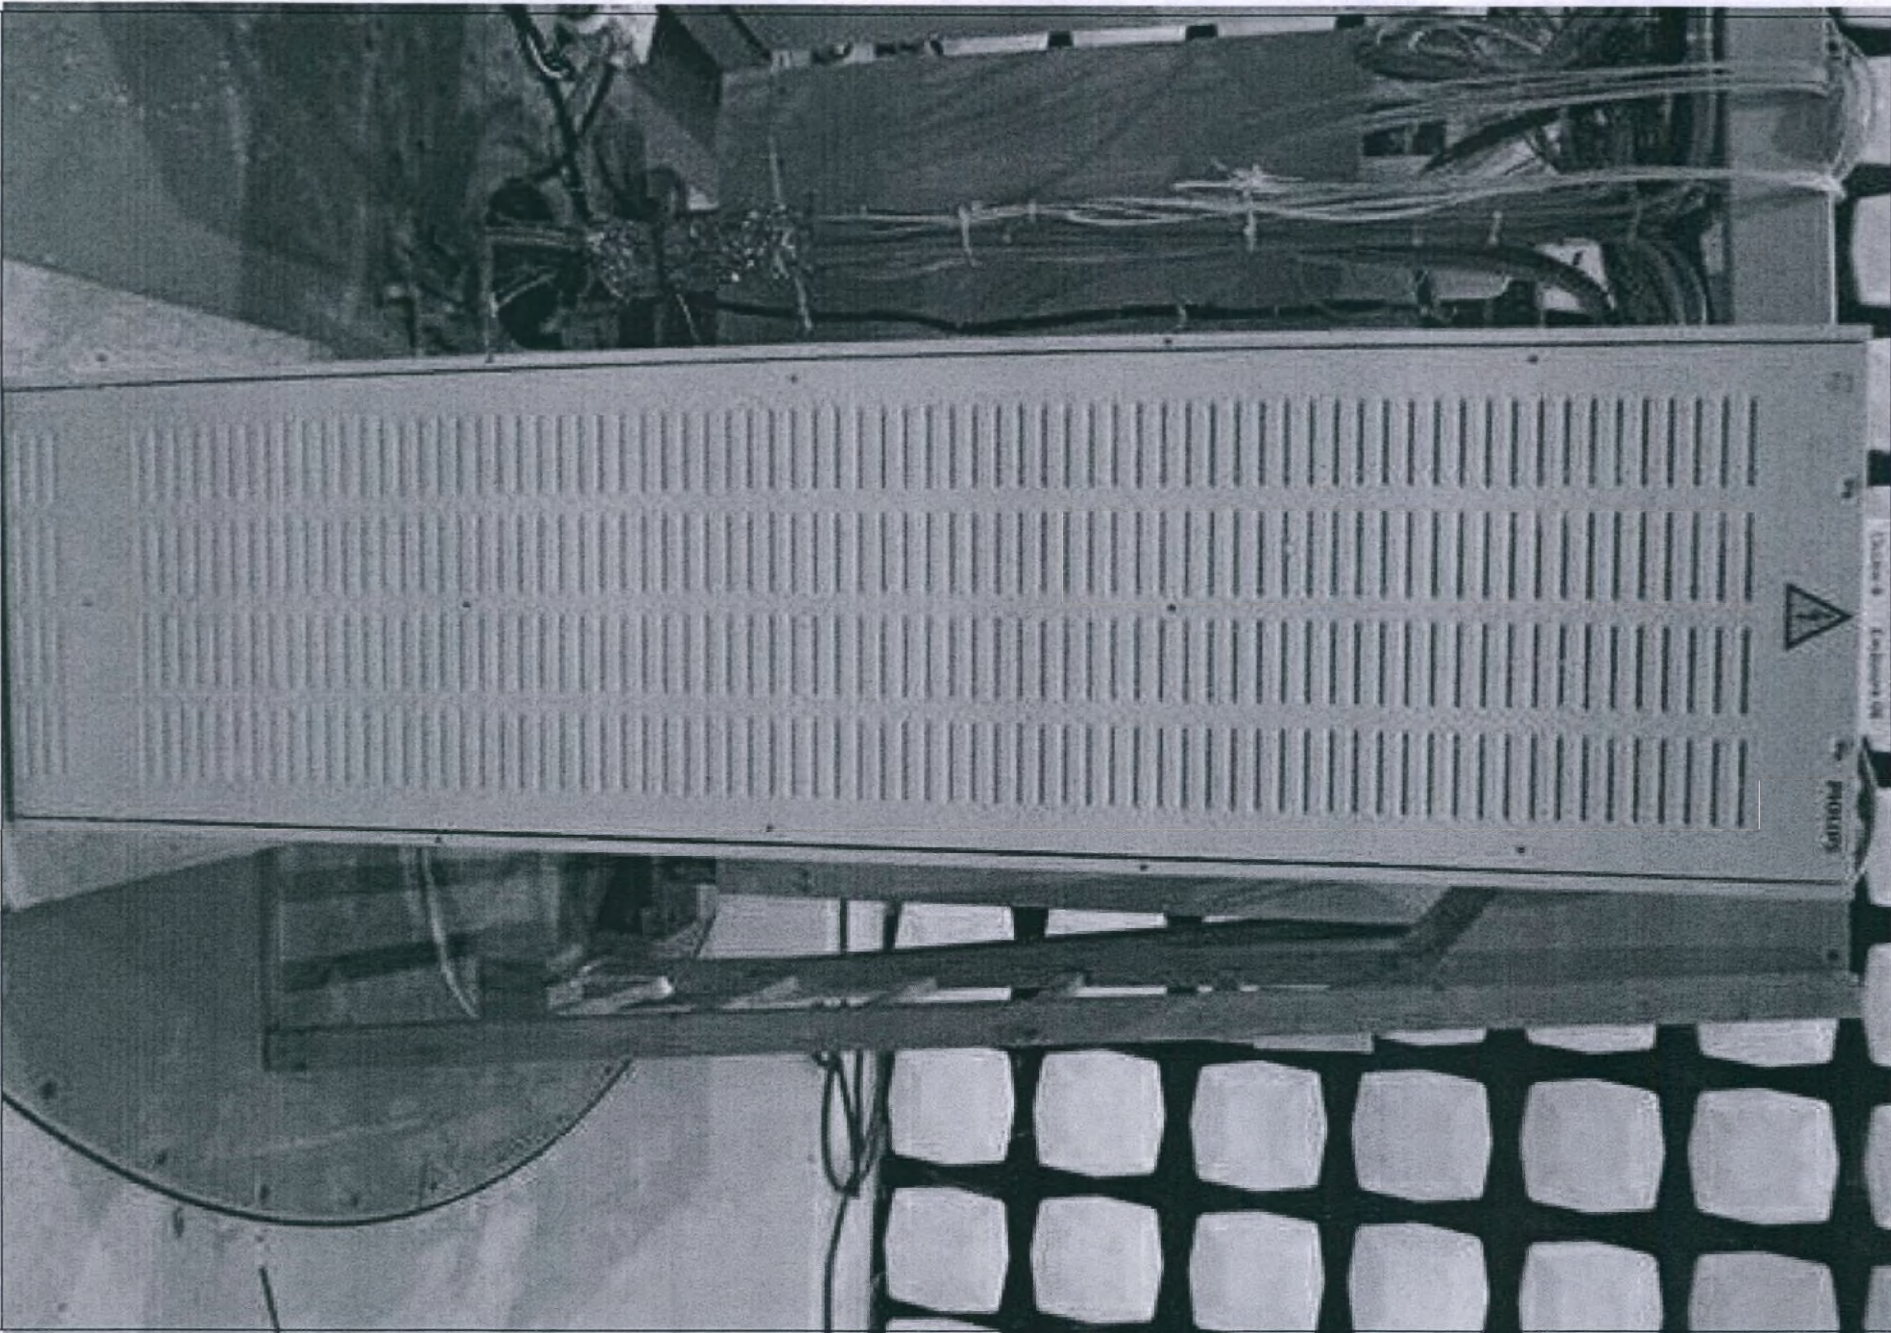


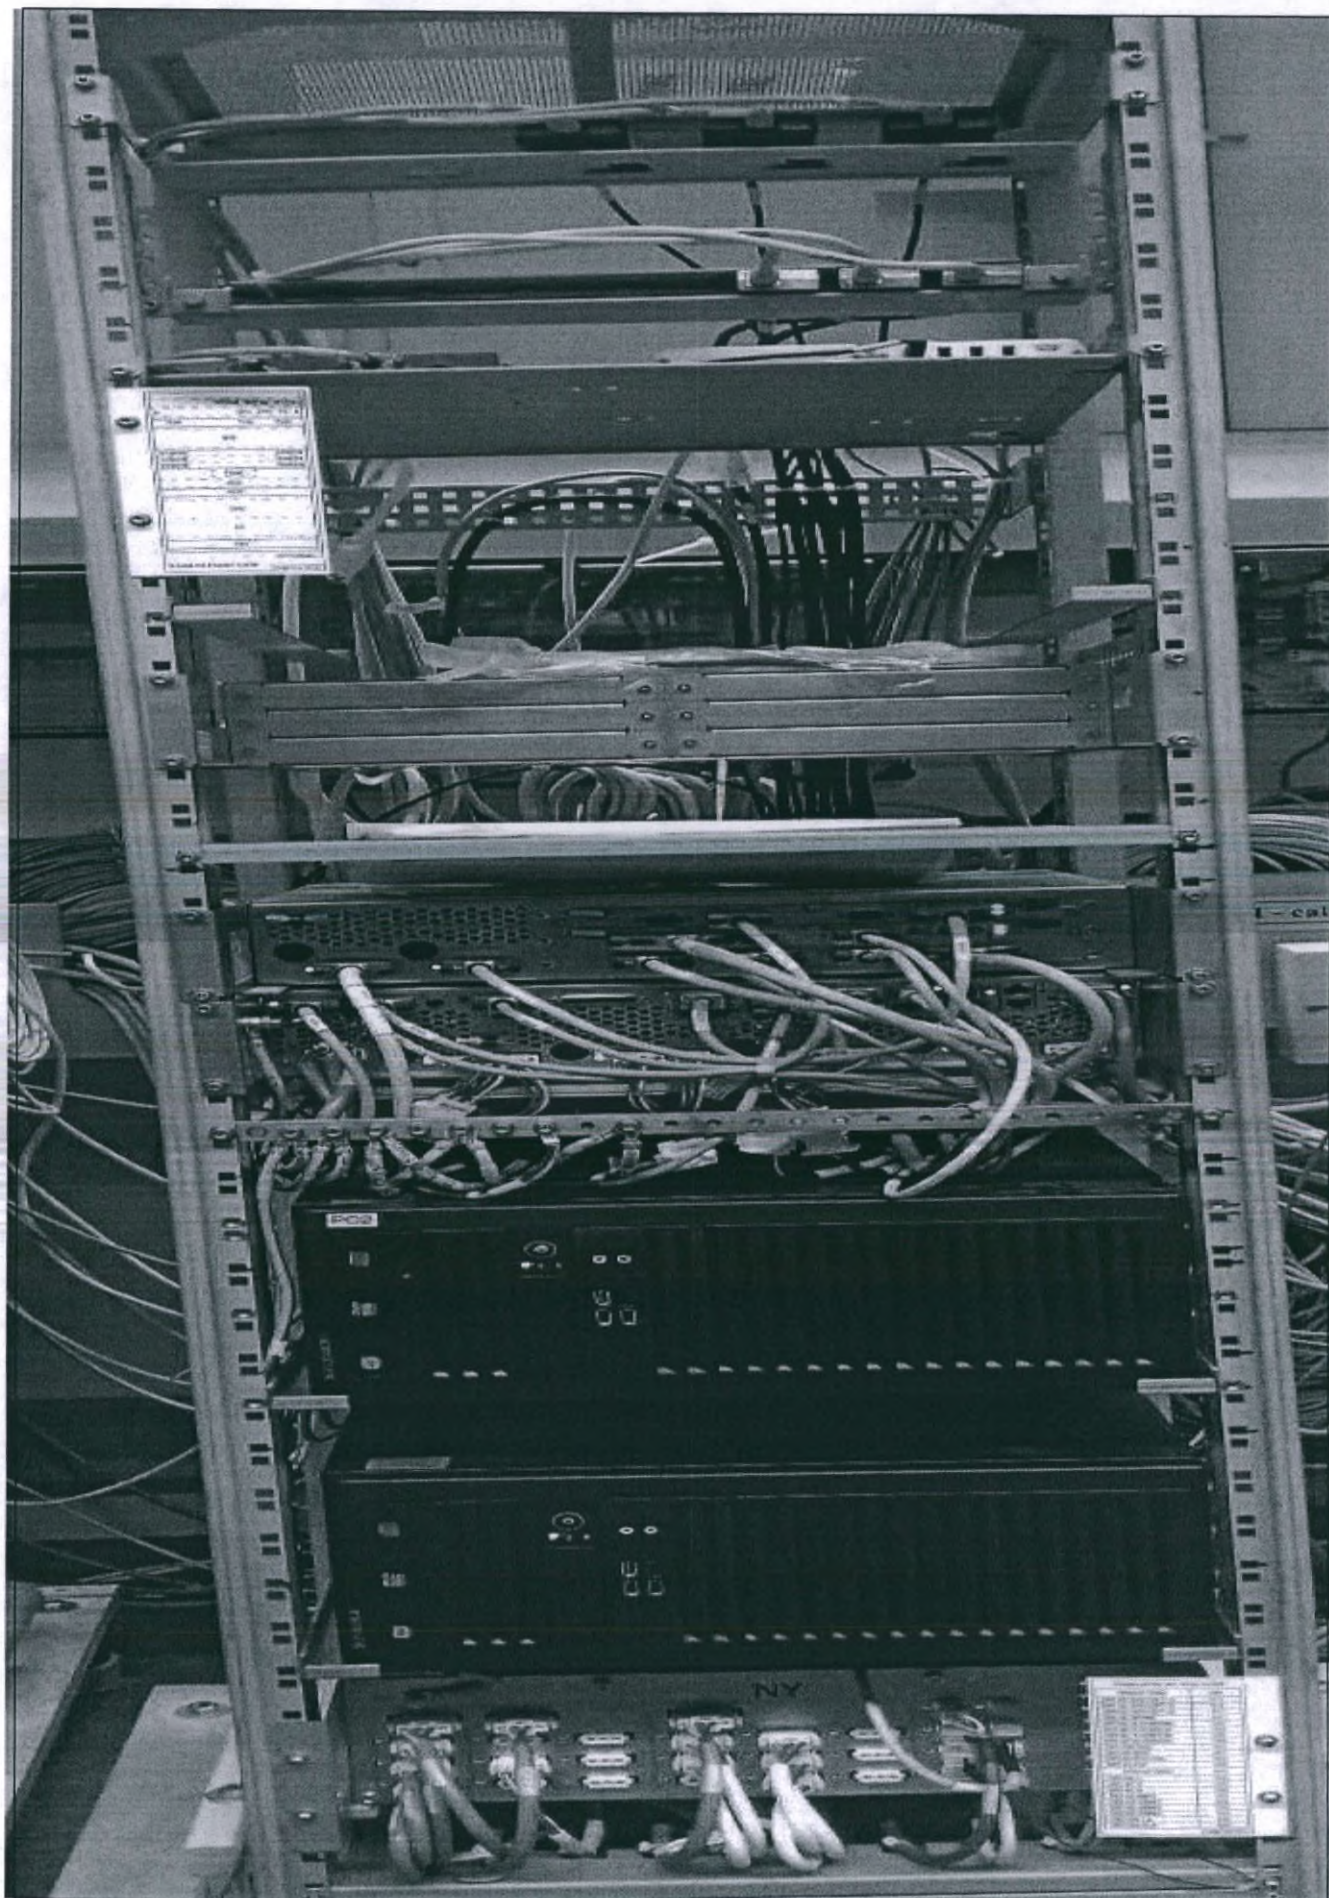

4.6. Шкаф управления.

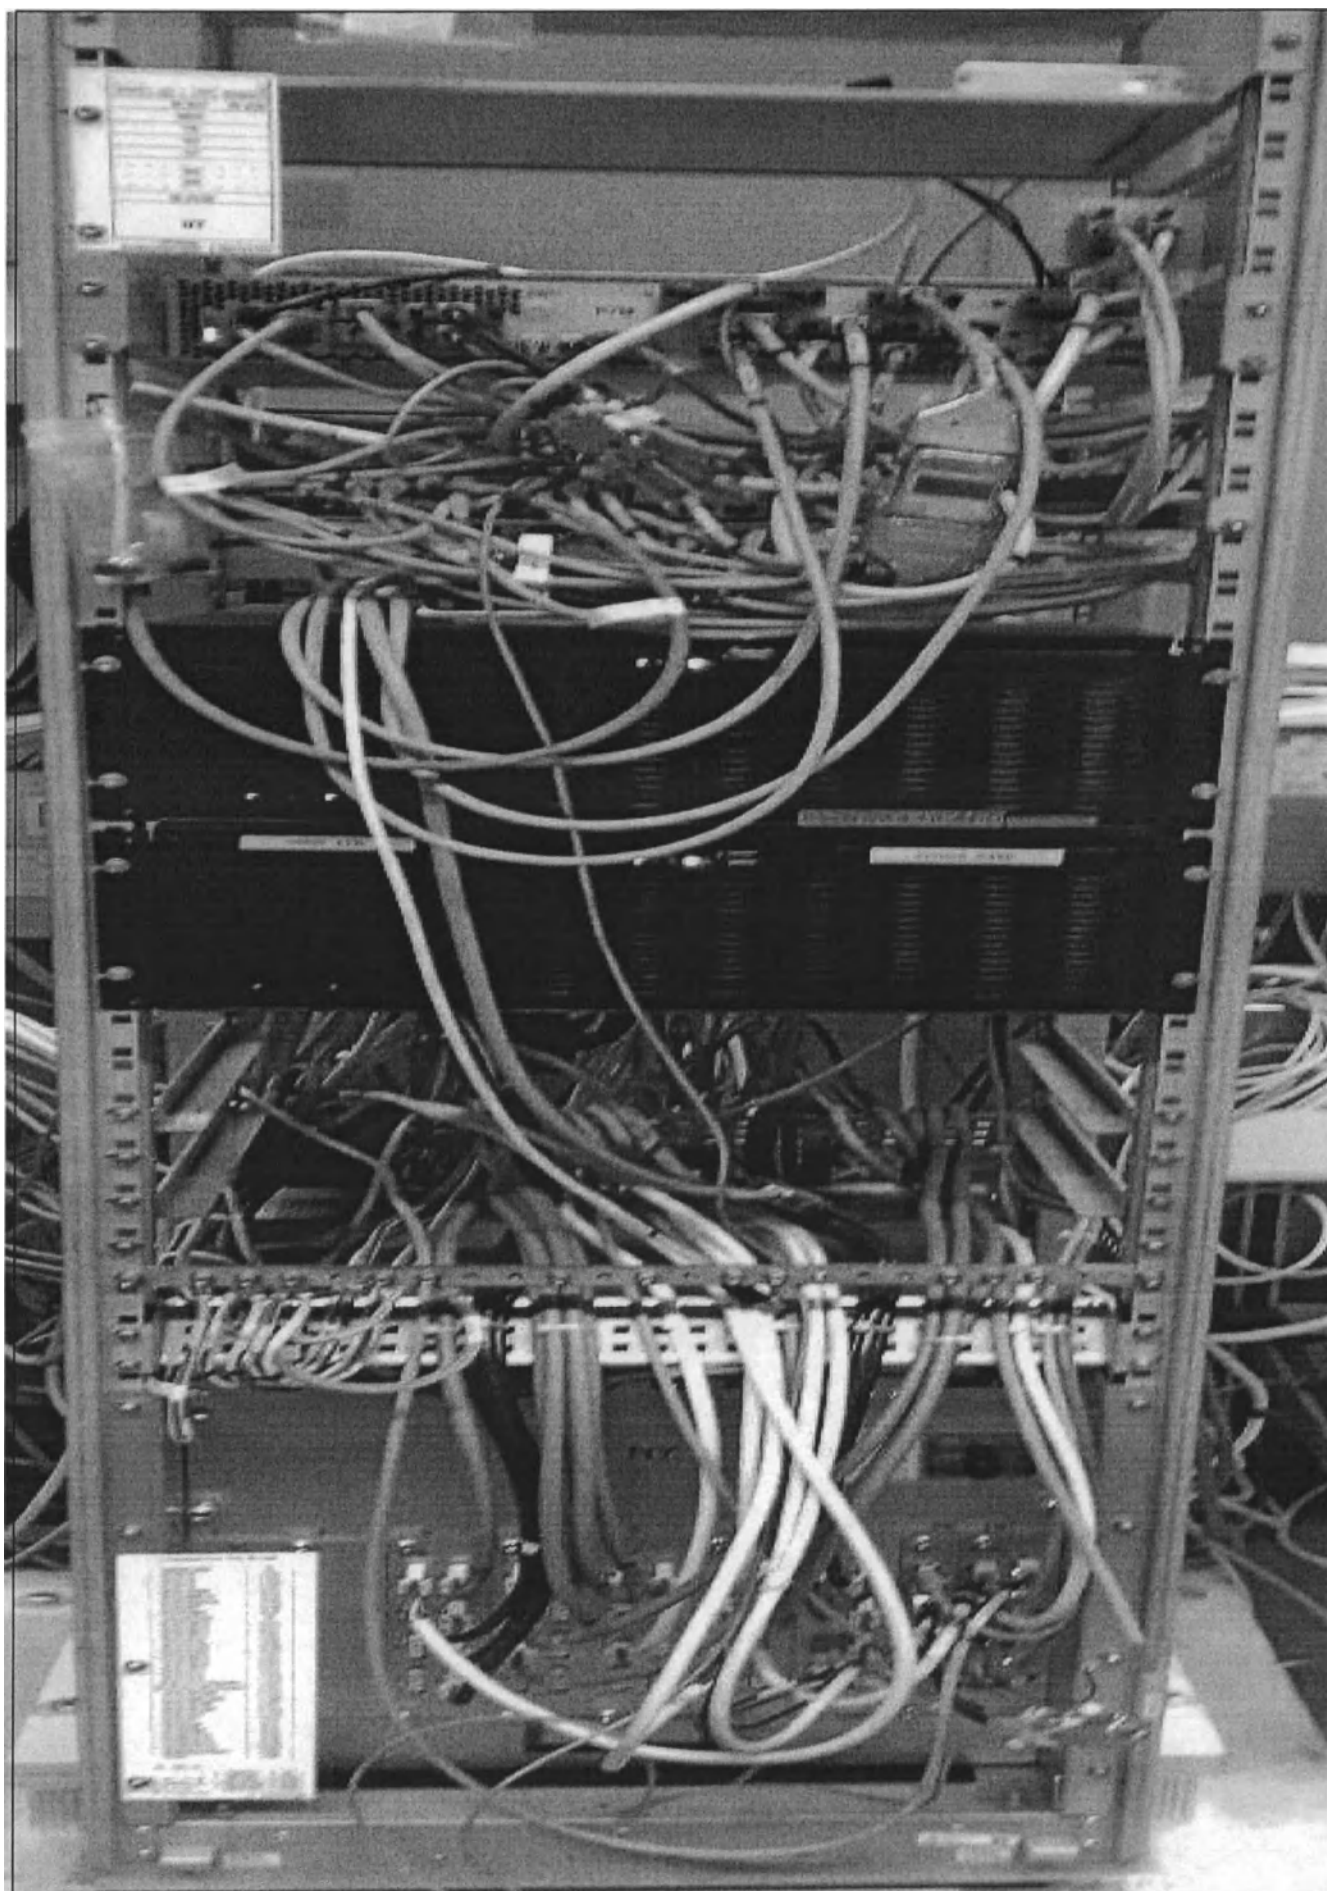


5.а. Распределительный щит.

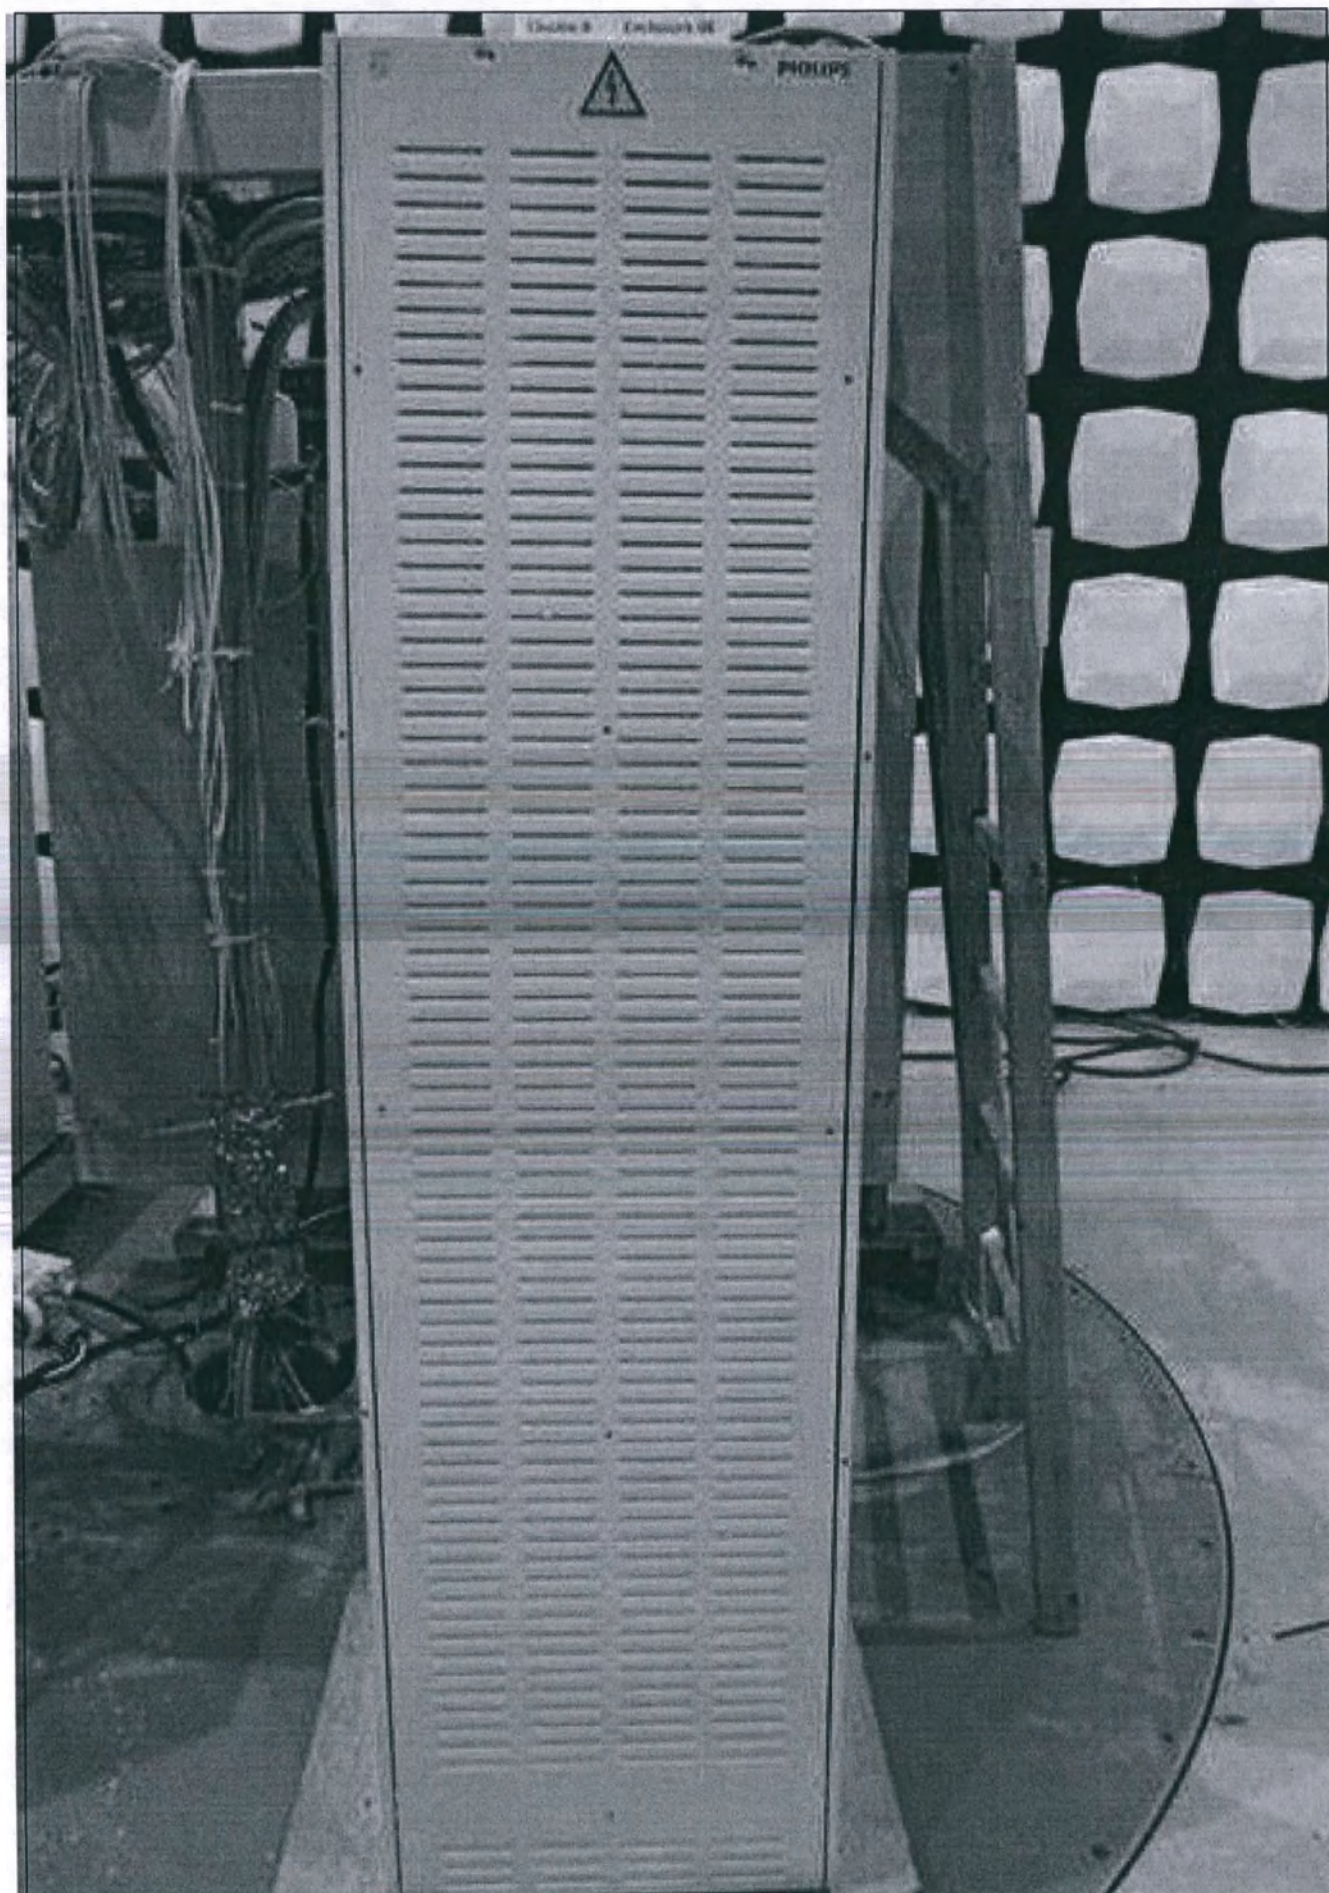


5.6. Распределительный щит.




6. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

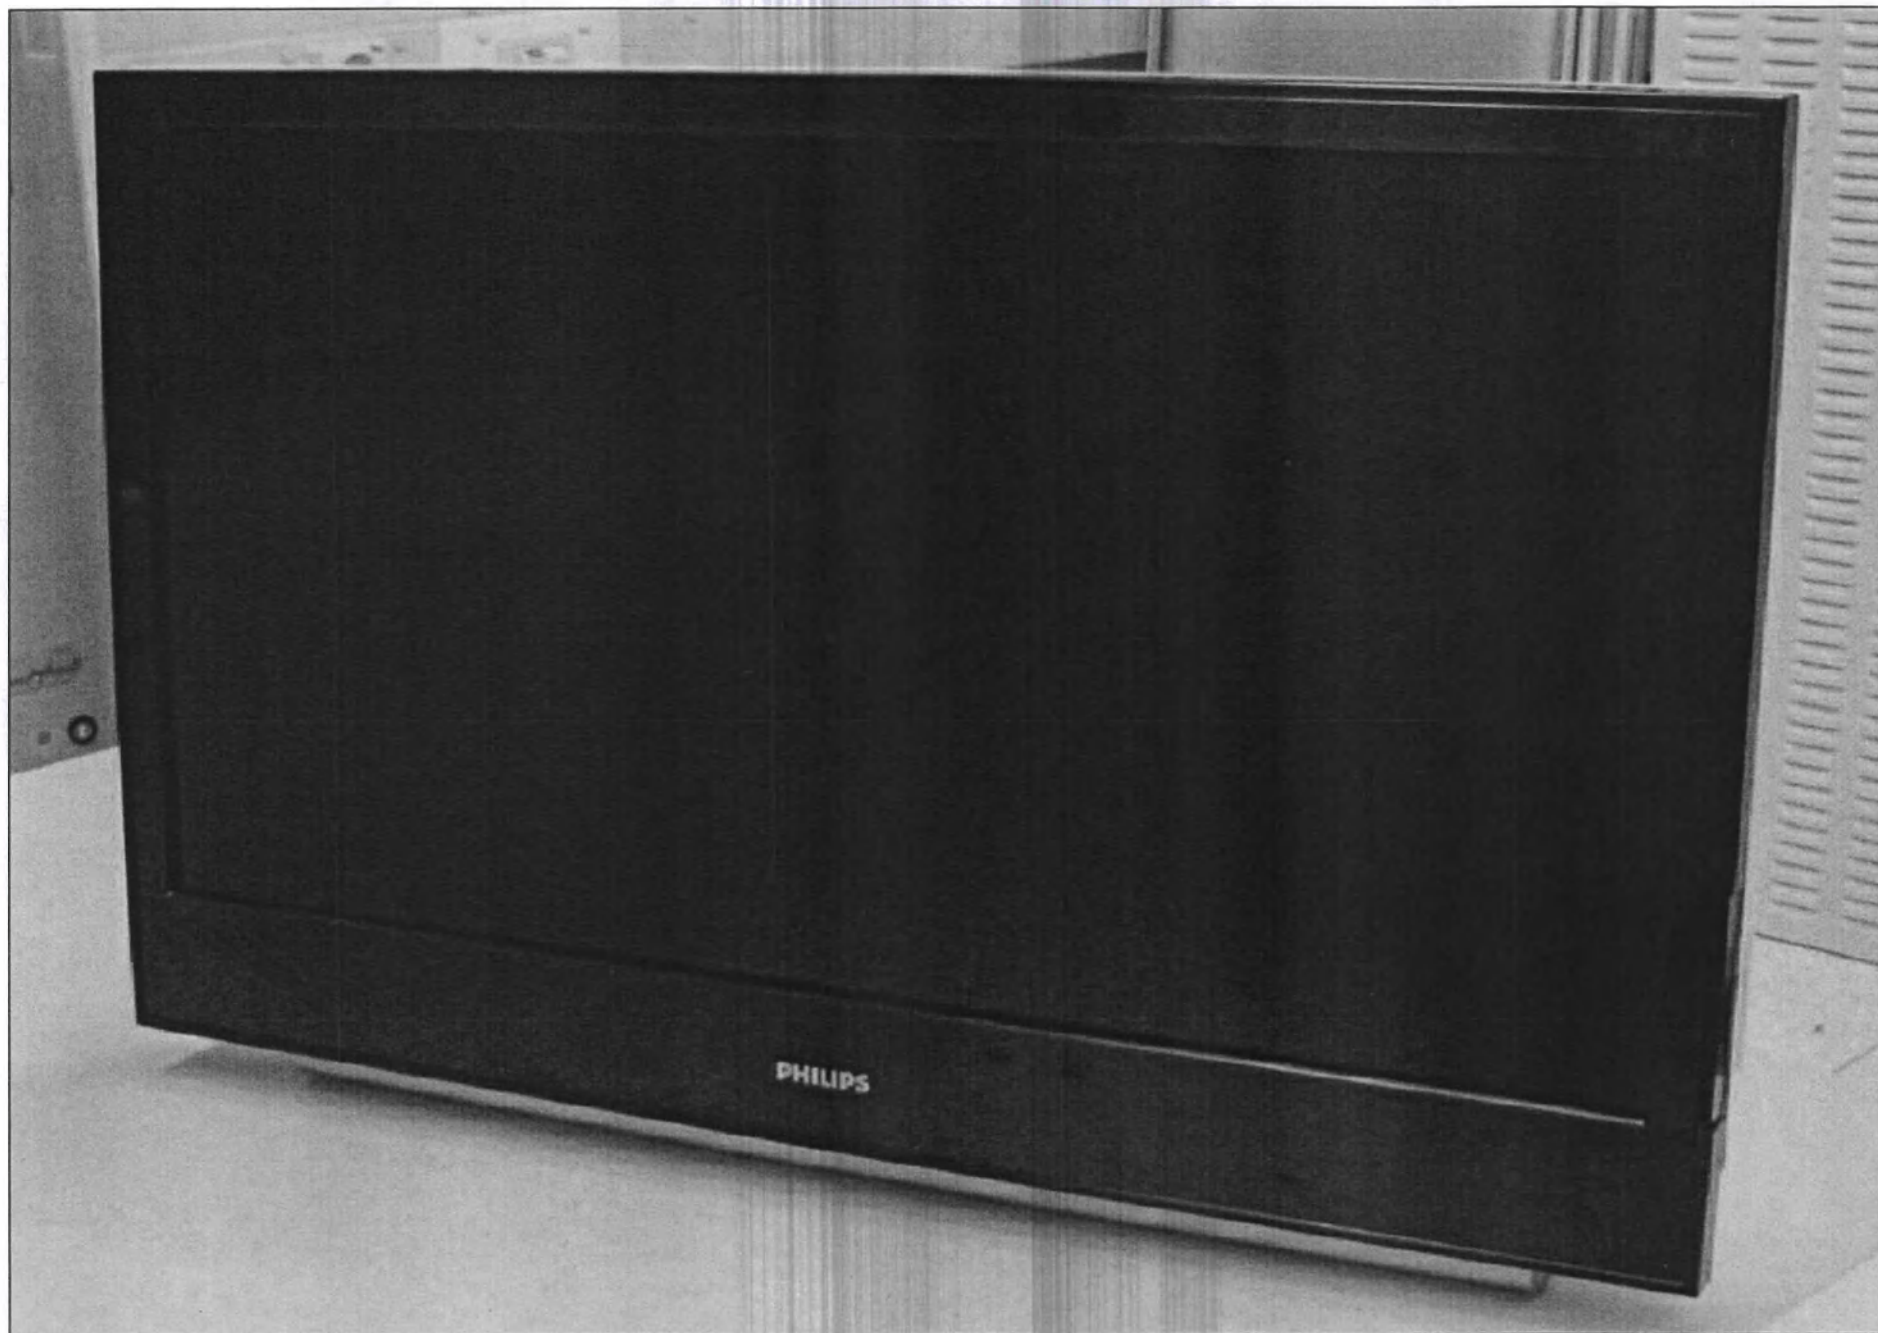

7. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

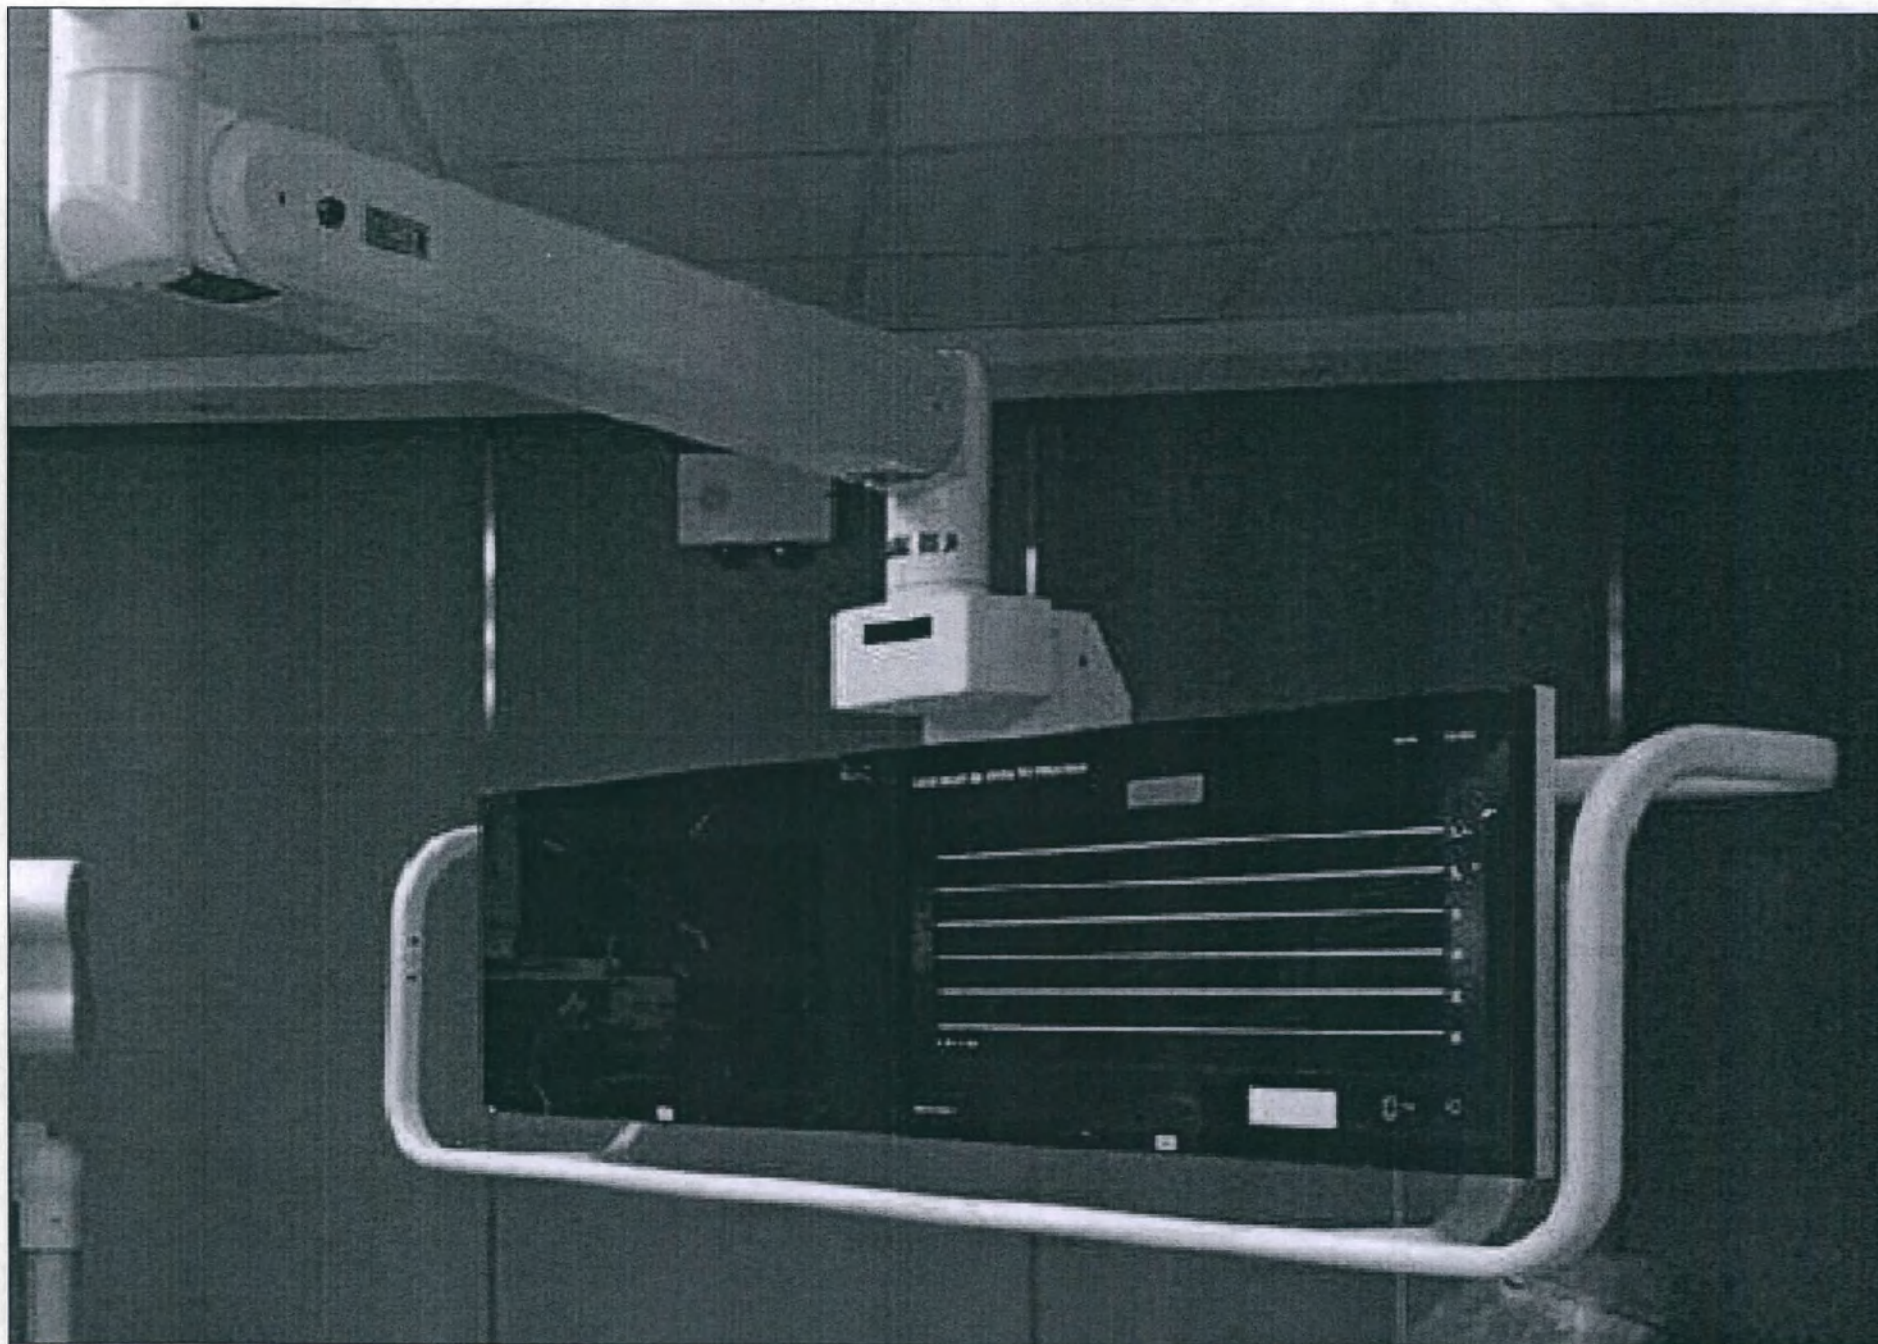


8. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

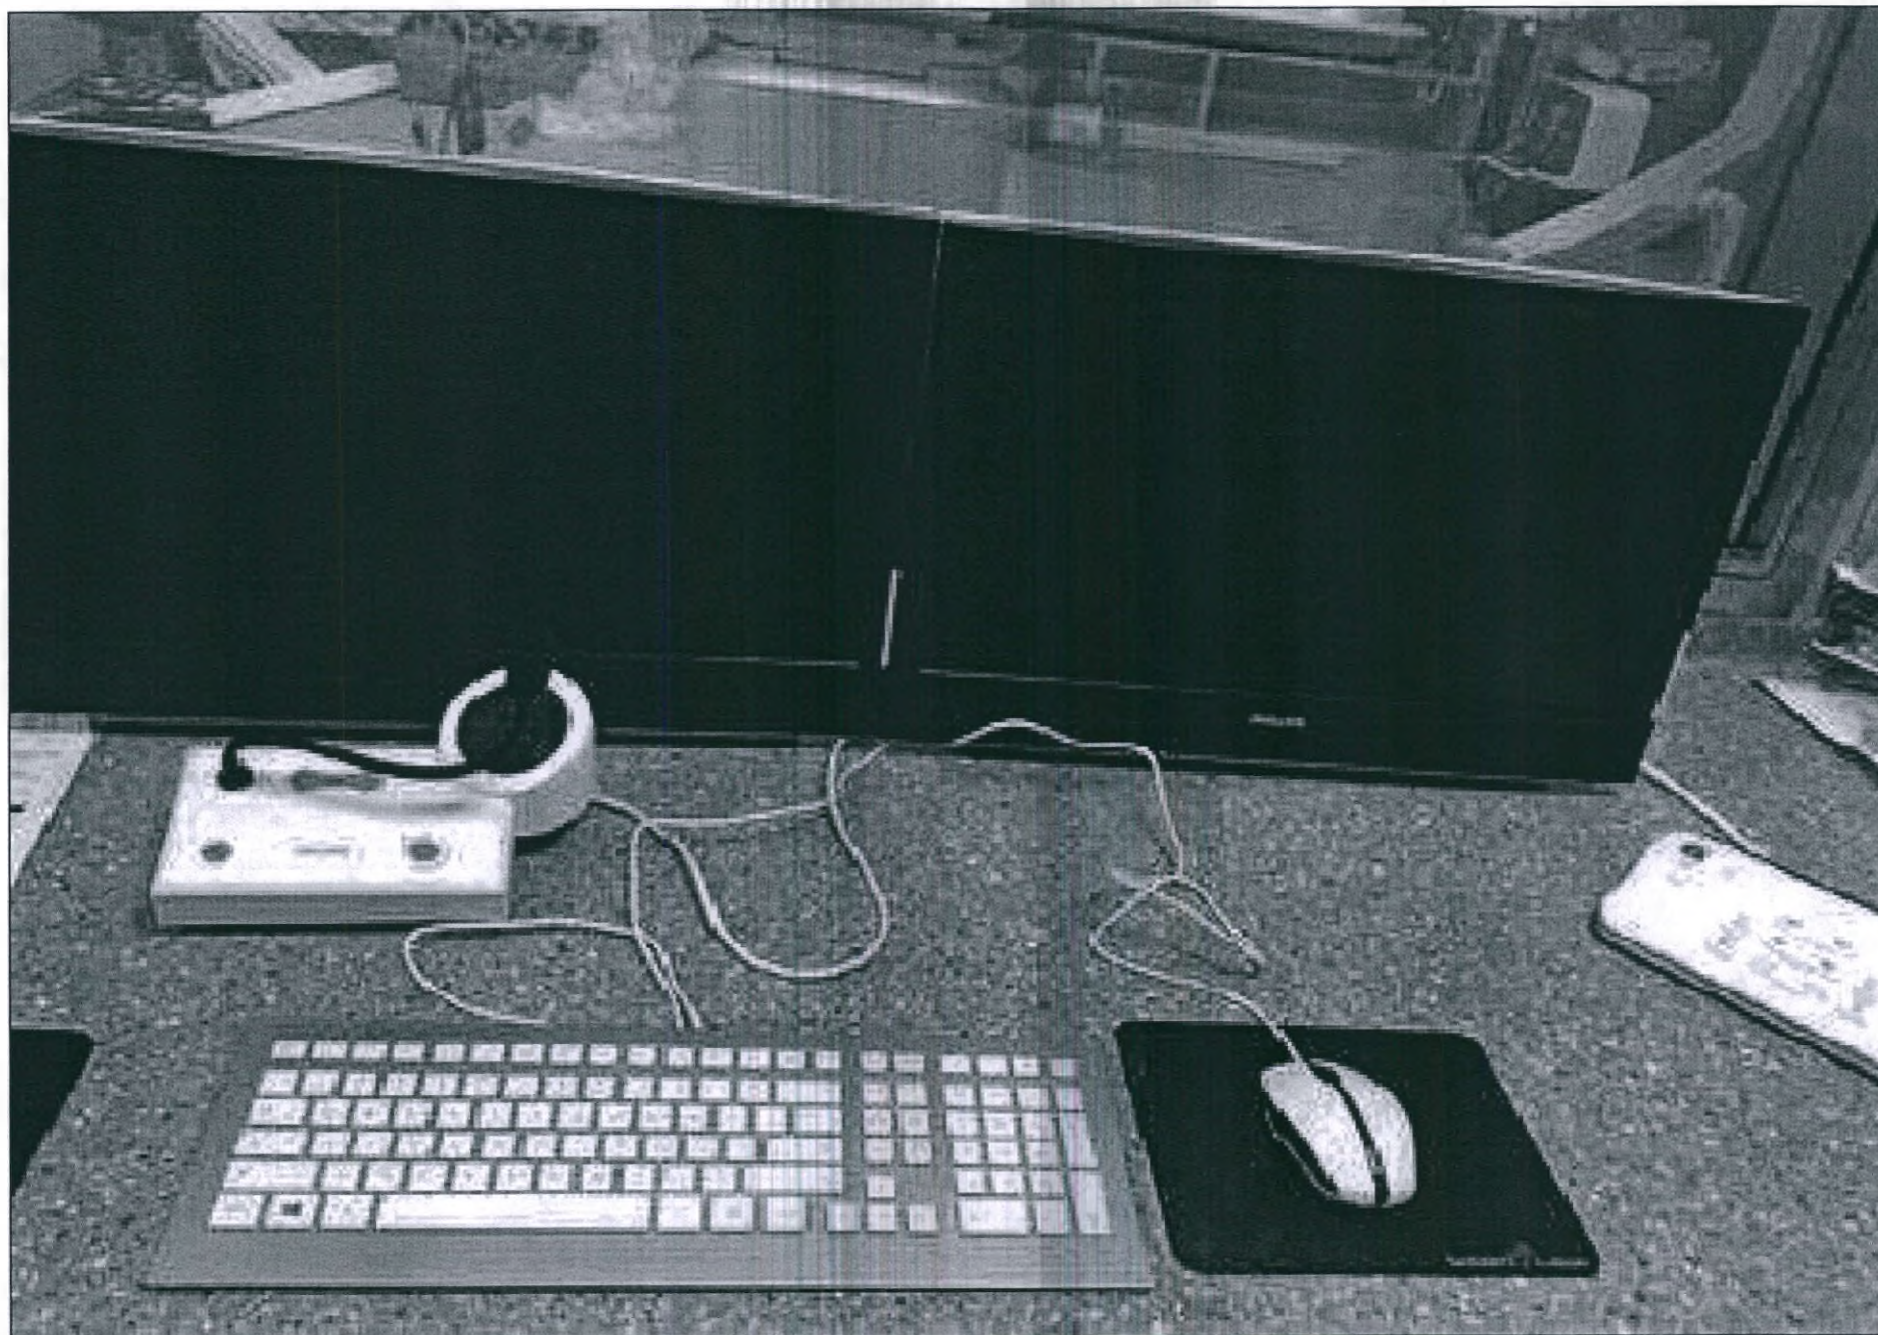


9.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.




9.6. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

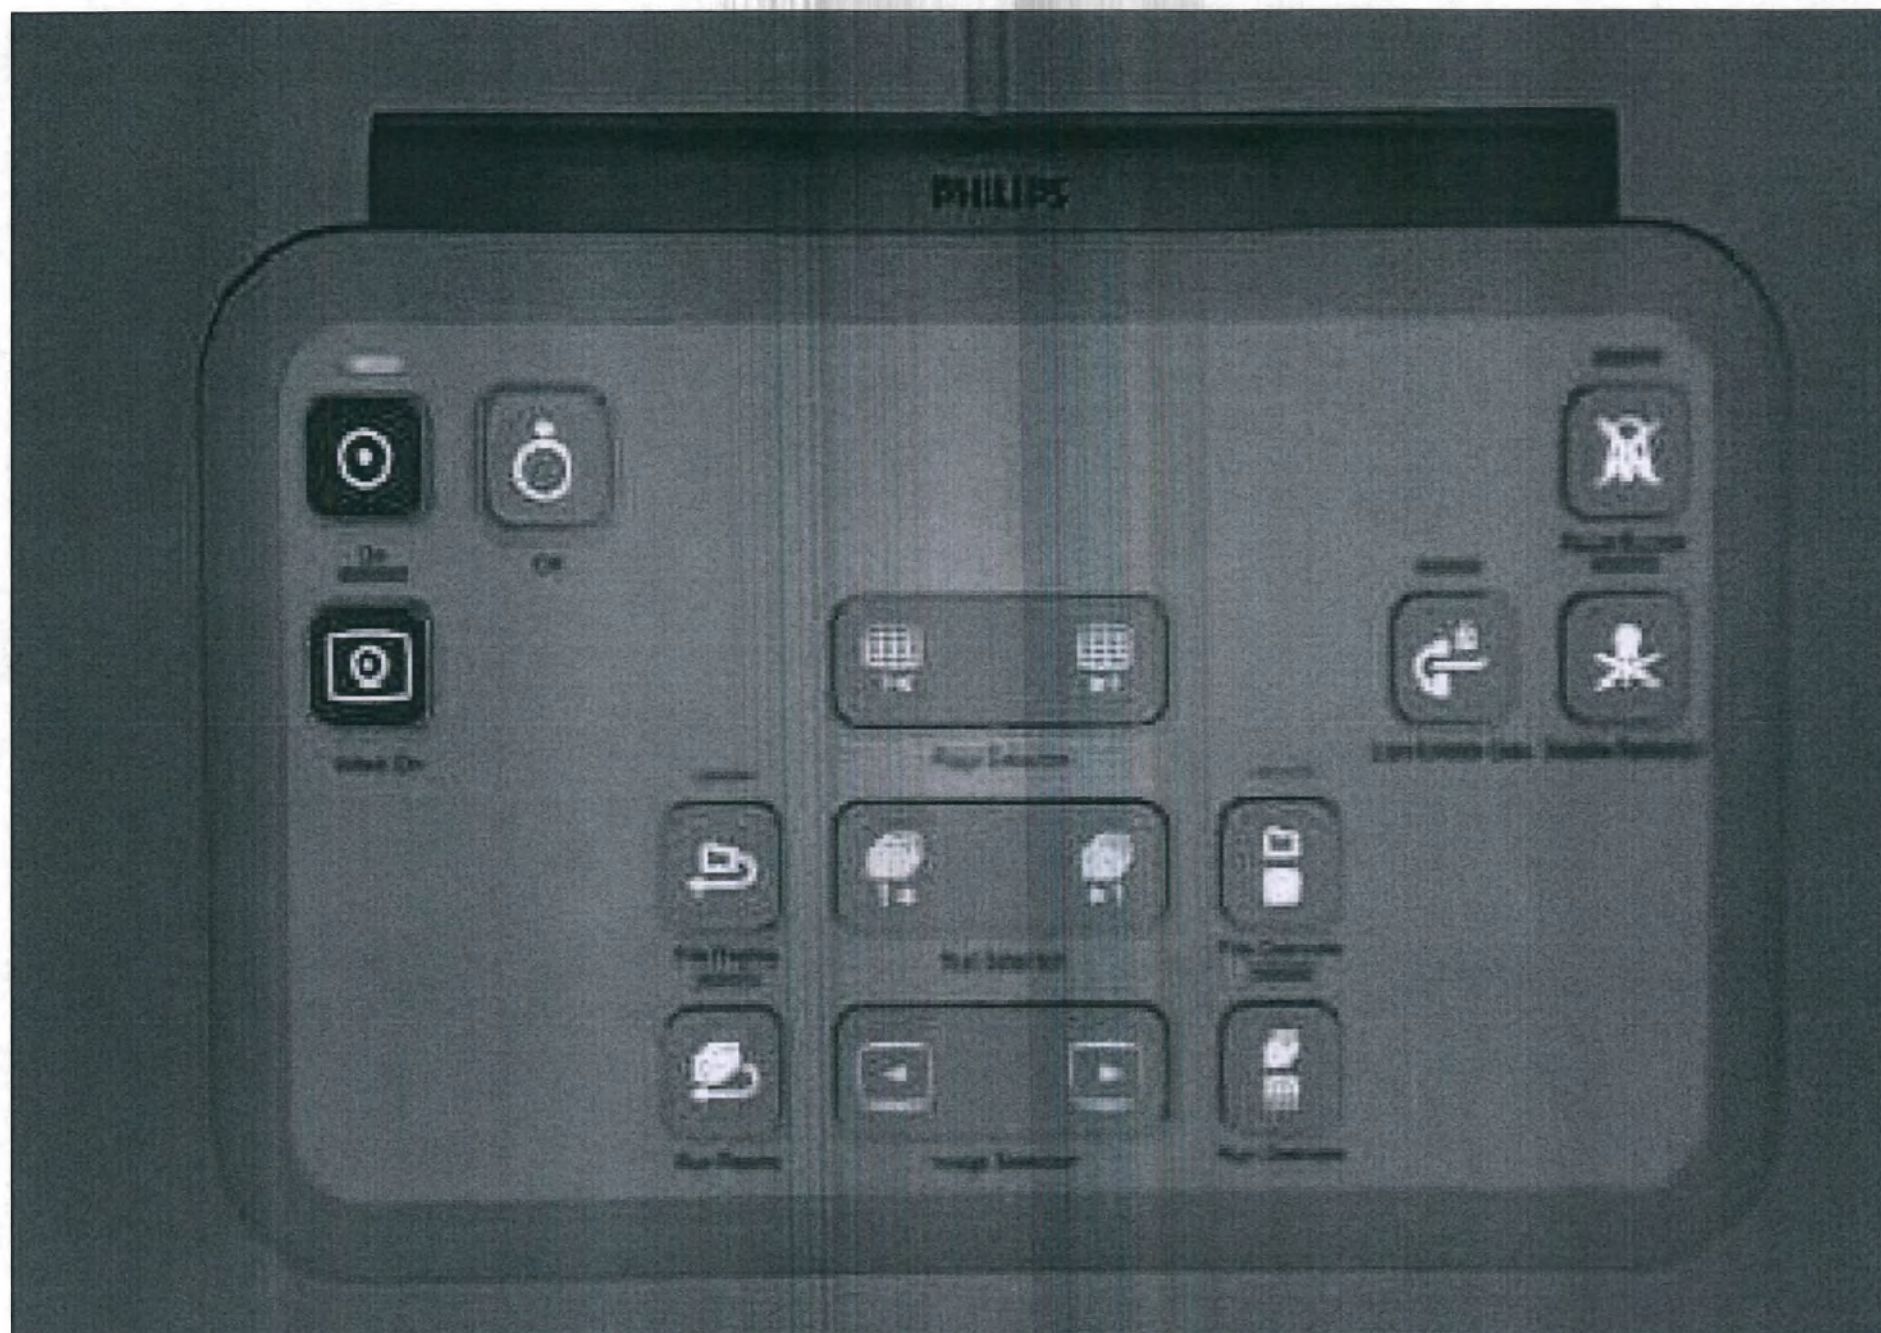


9.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

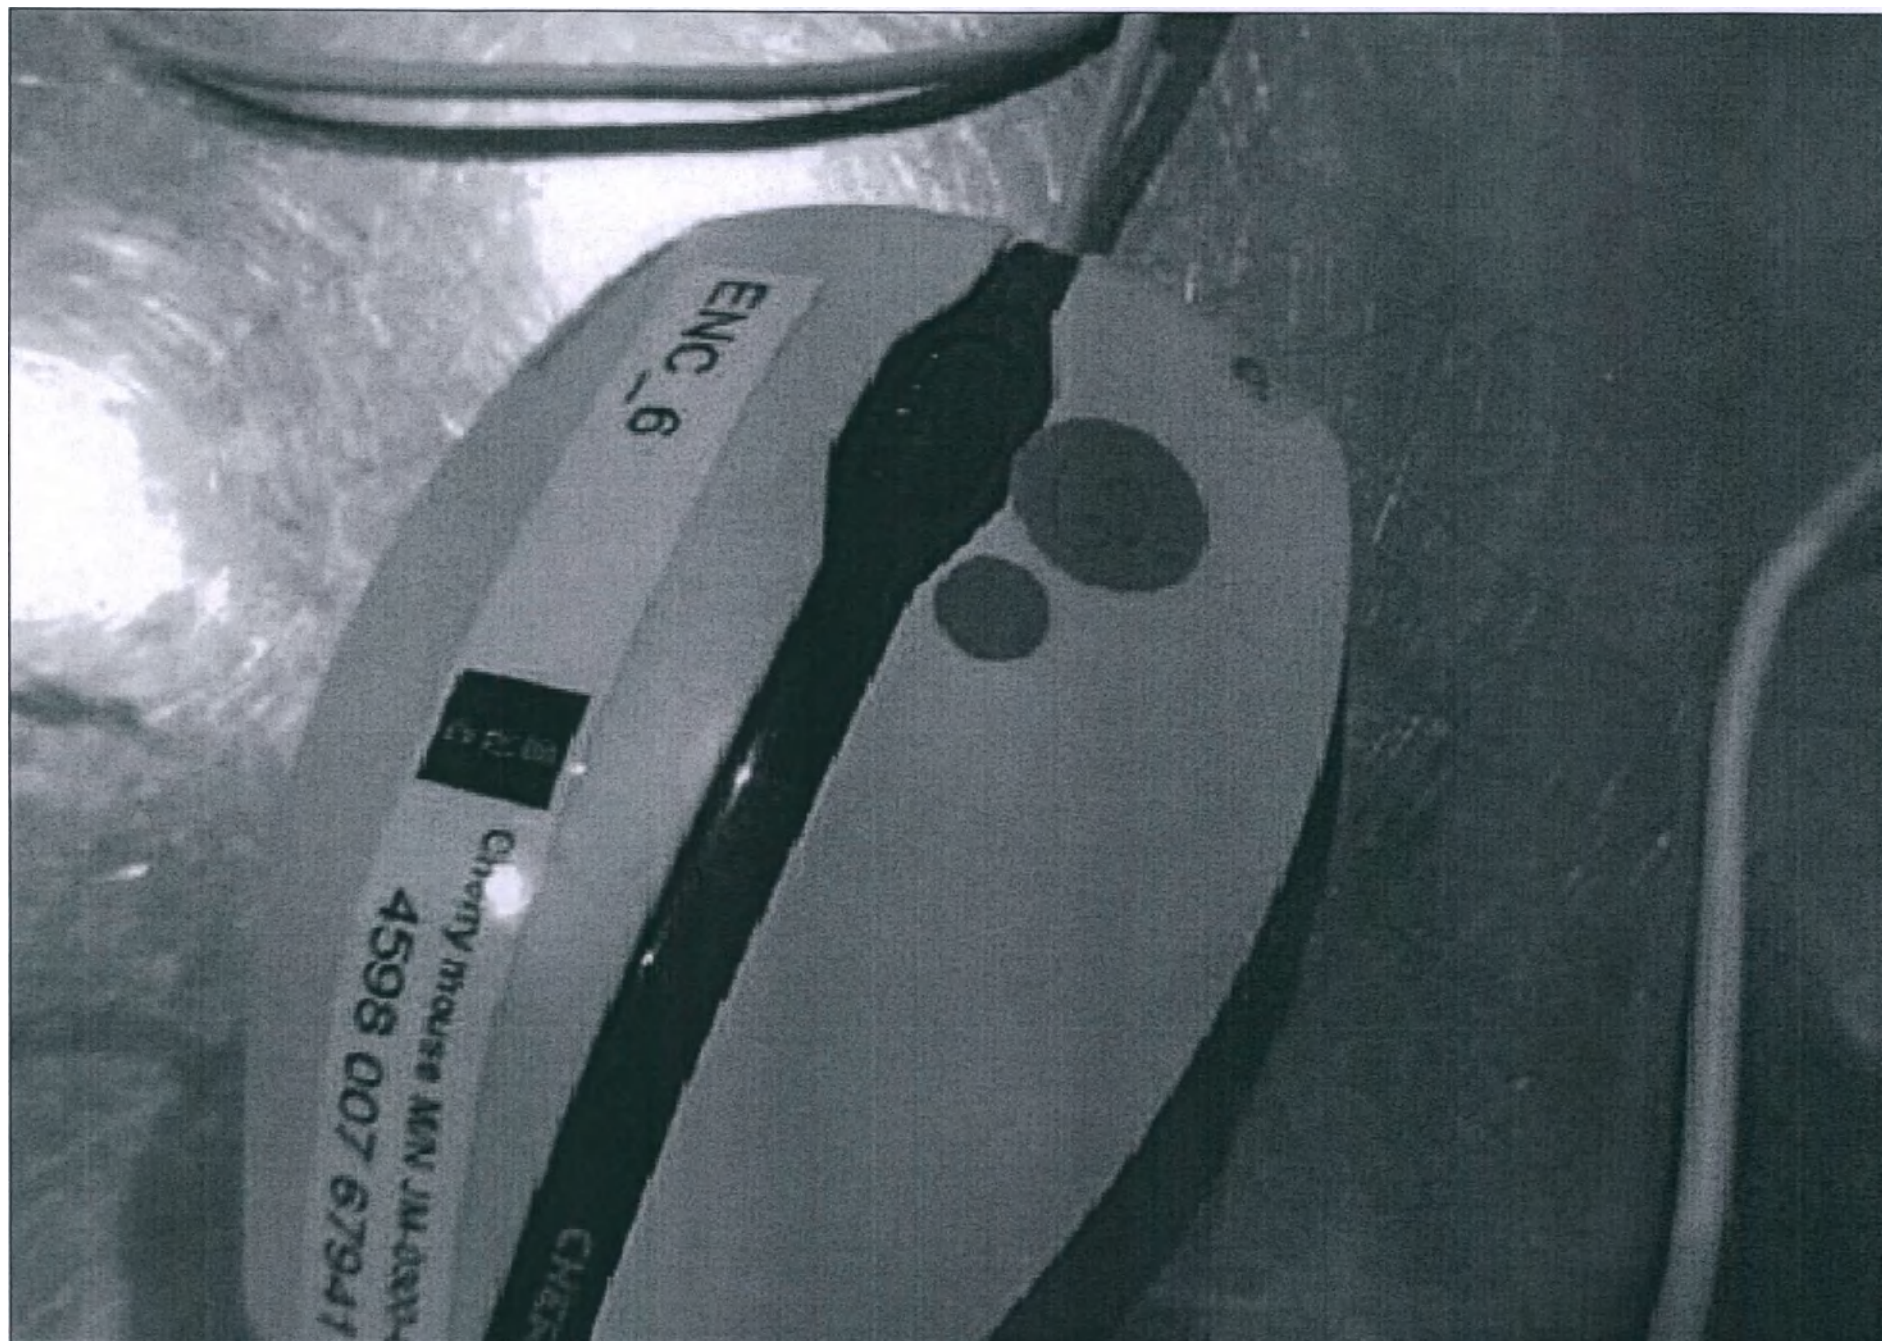

9.2. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

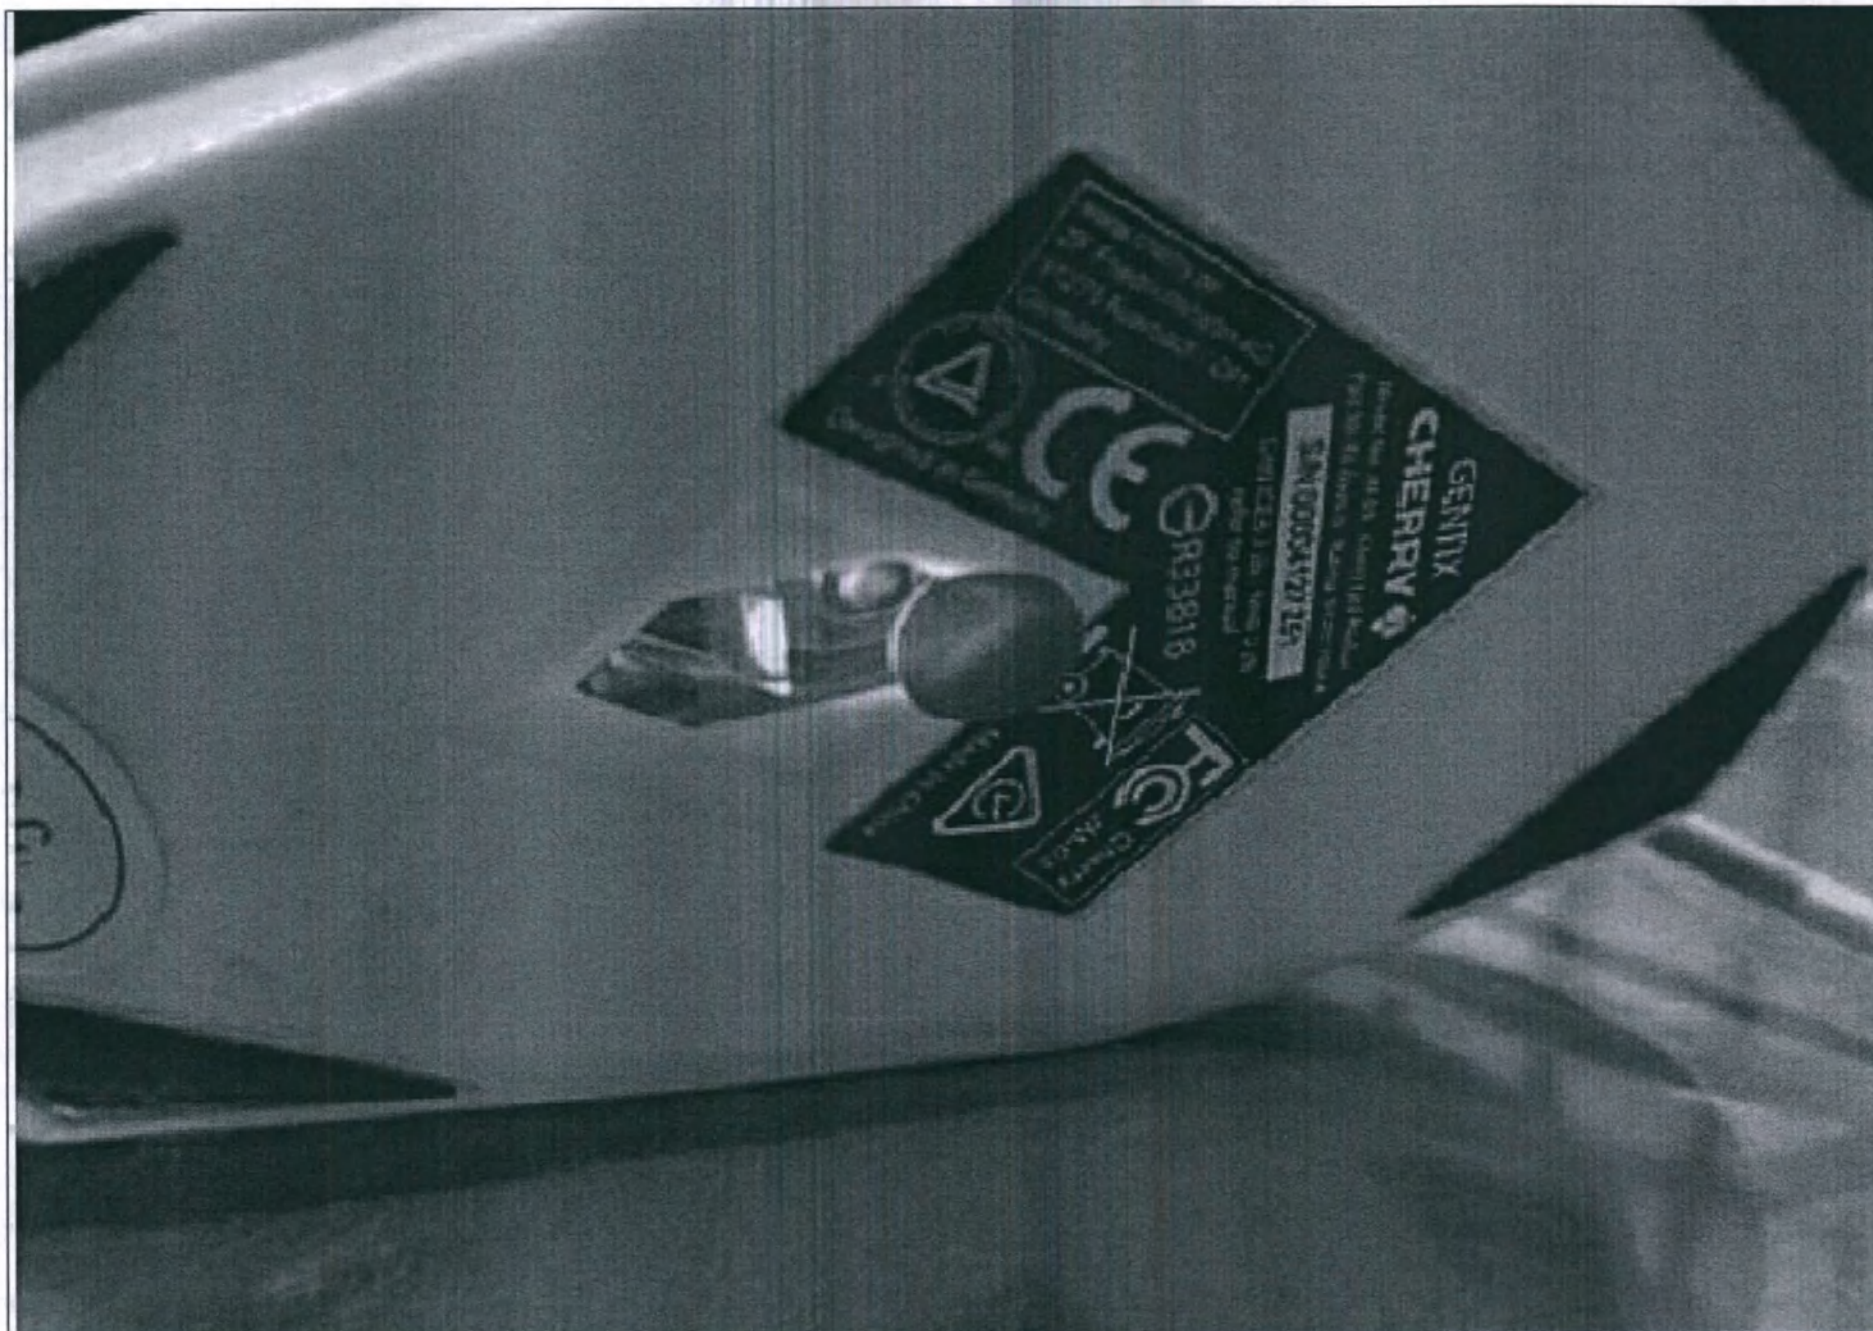


9.д. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

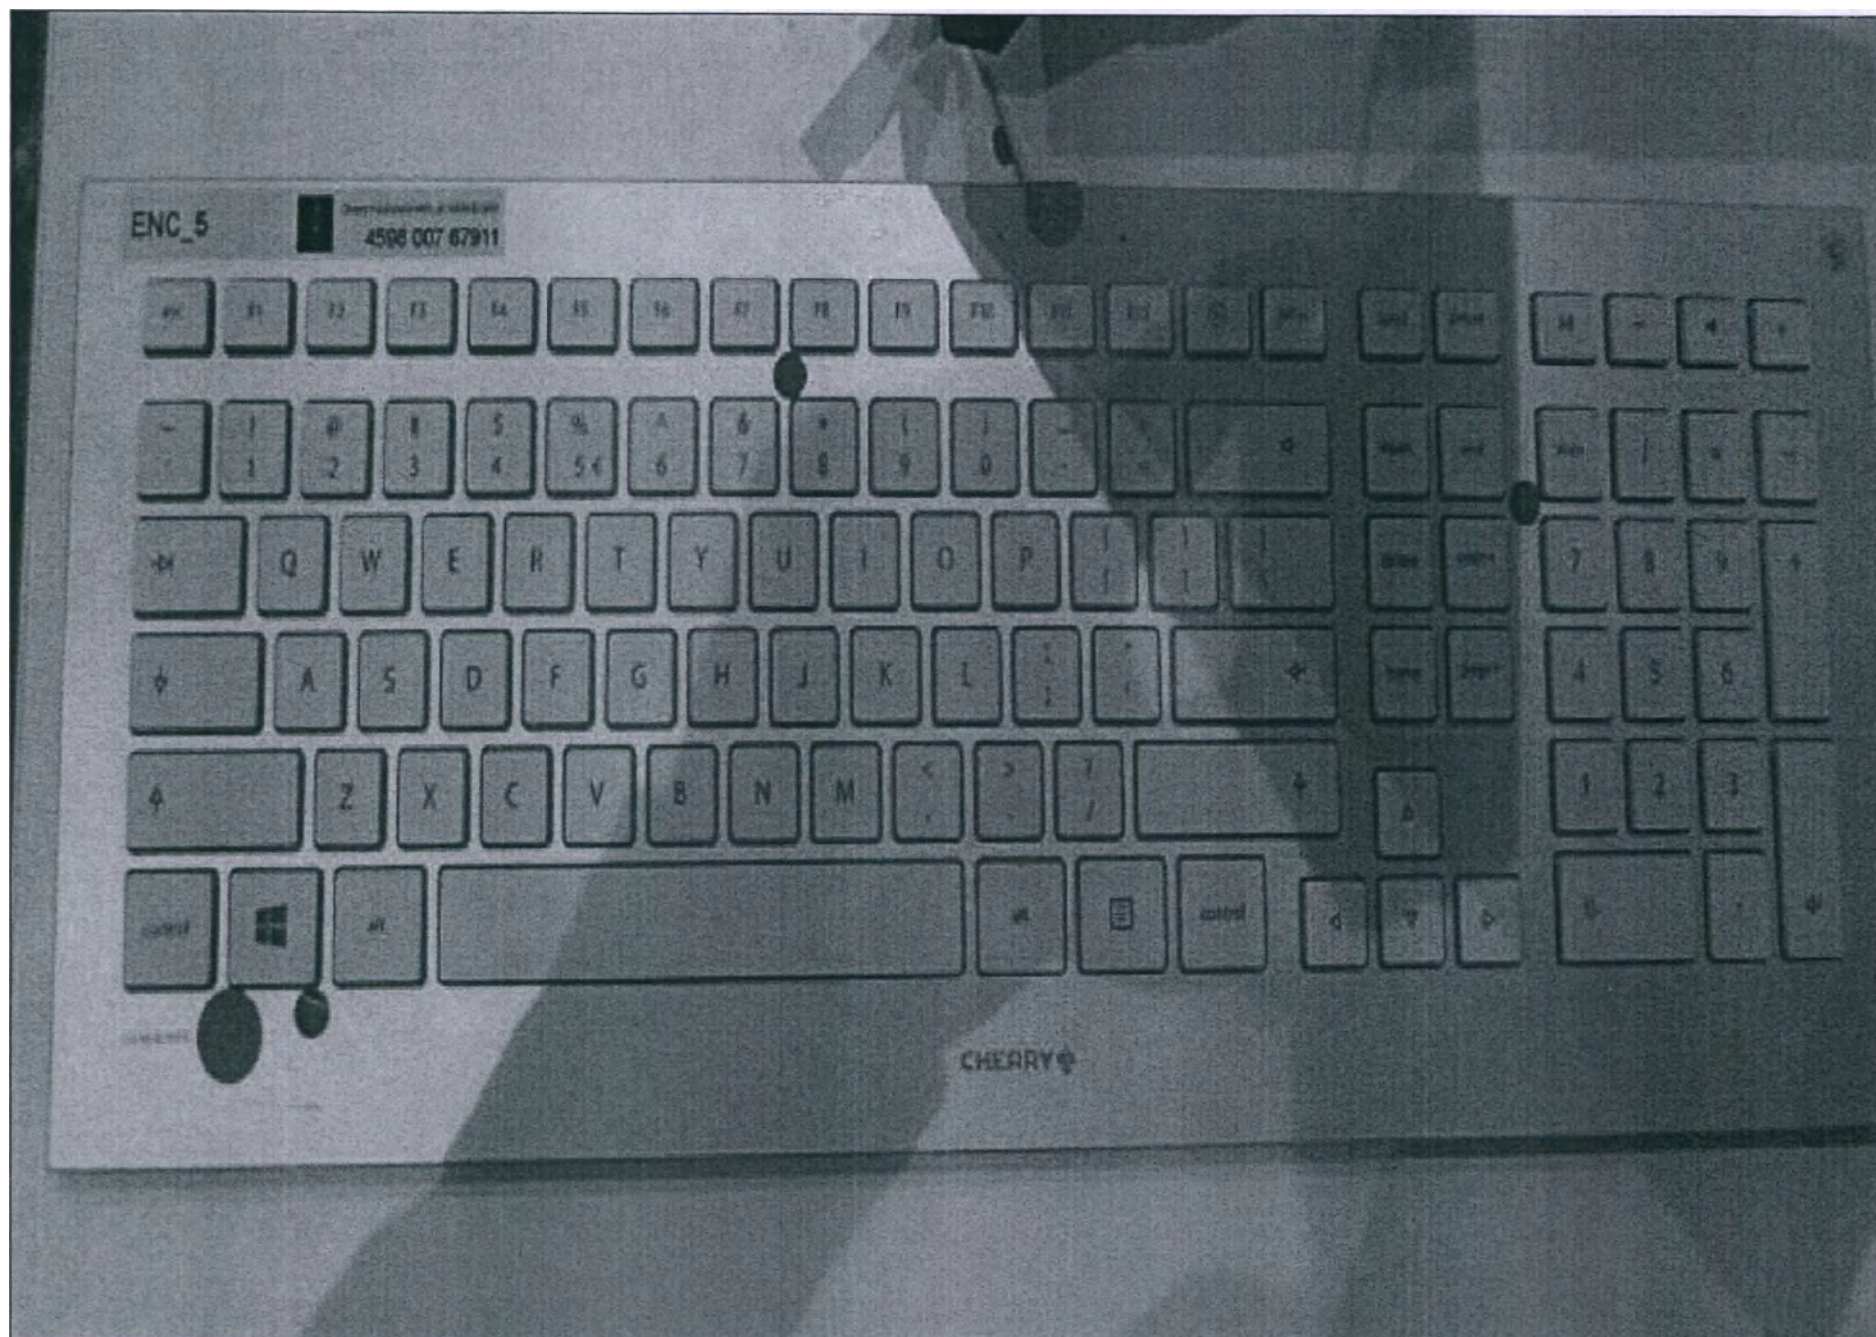


9.е. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.



9.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.1 и выше.

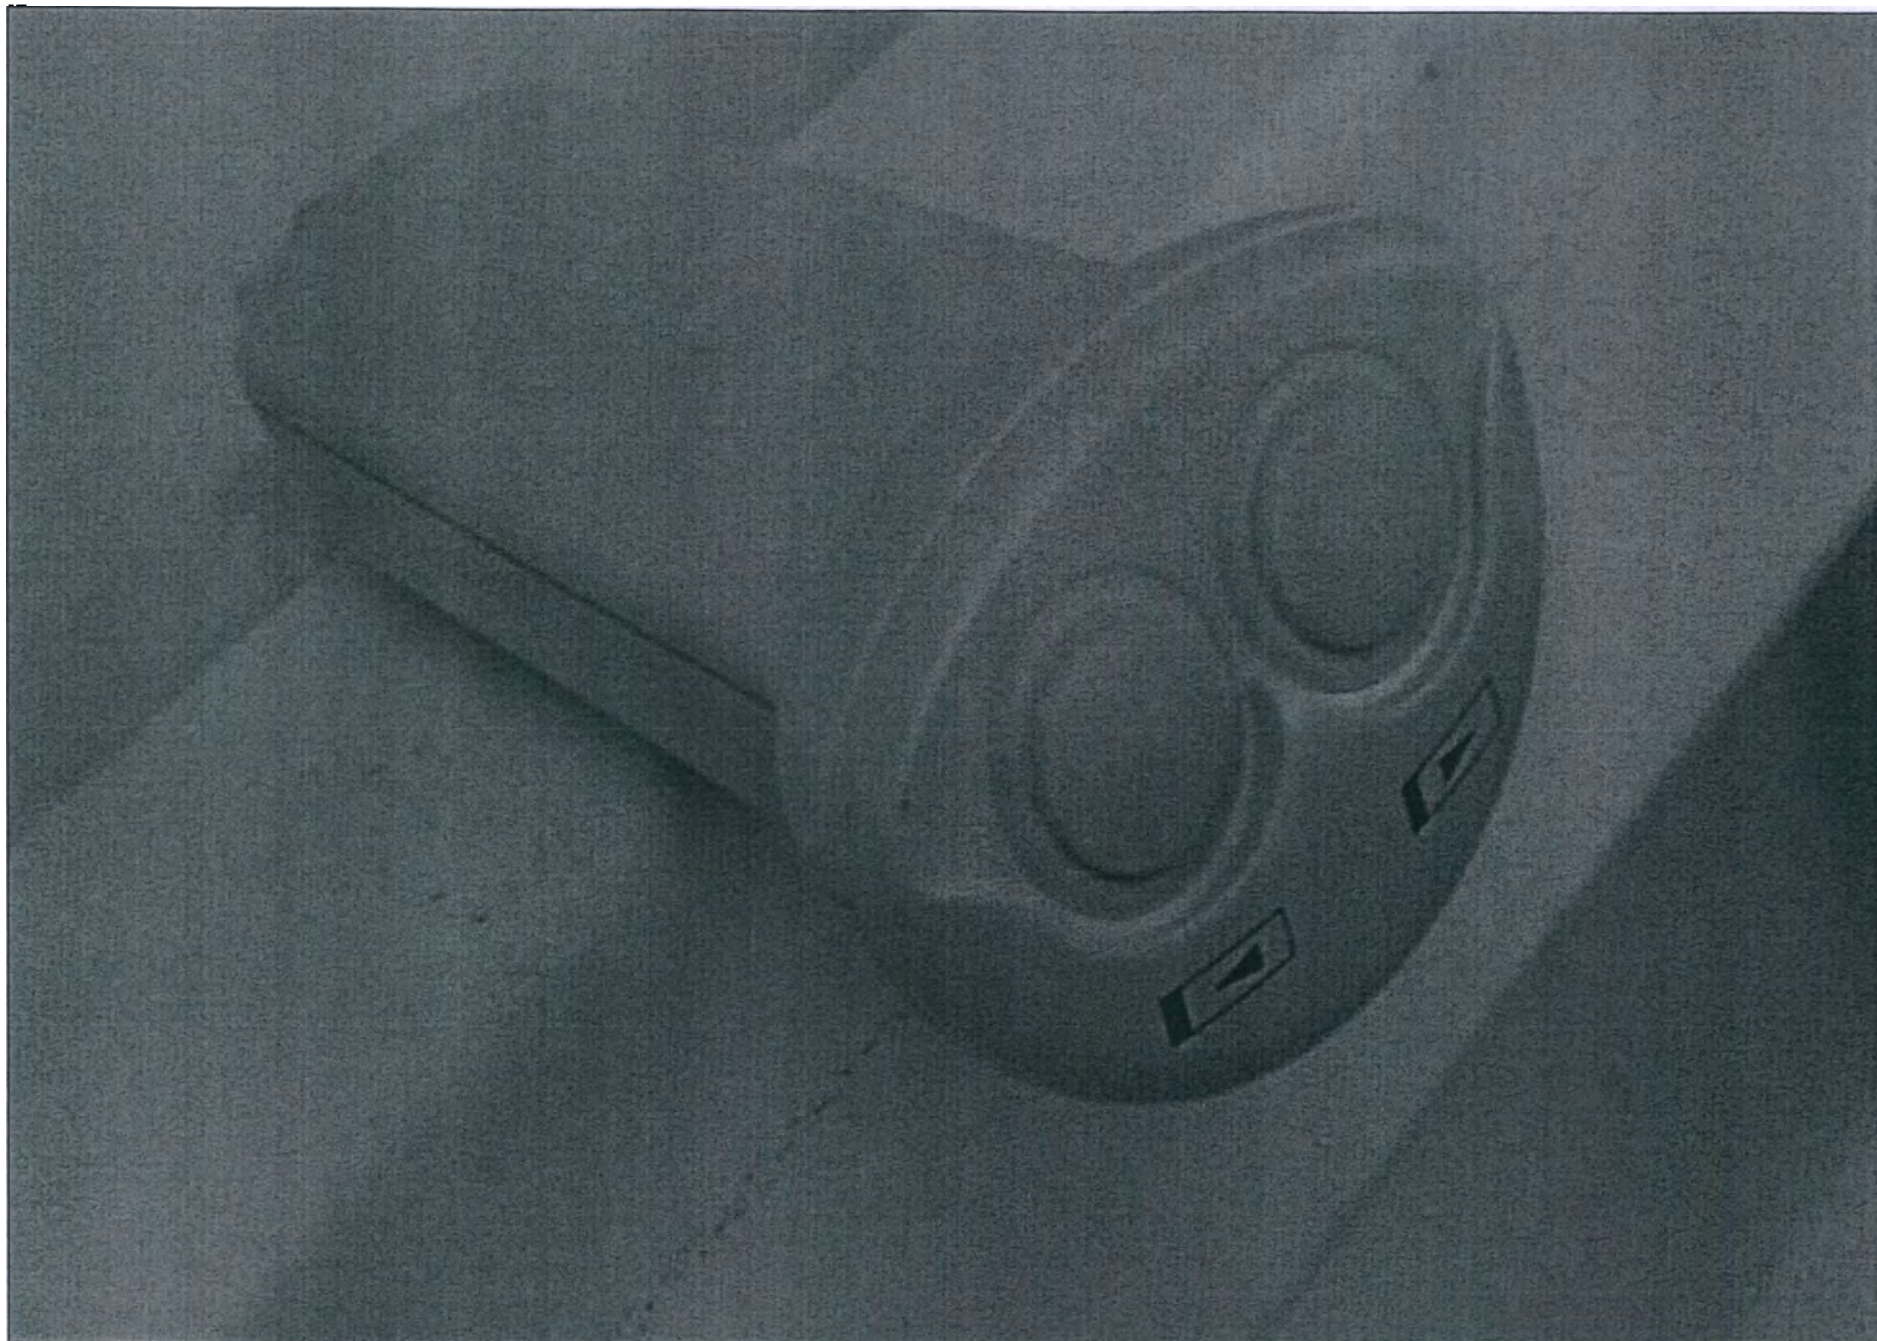


10. Ручной переключатель сдвига.

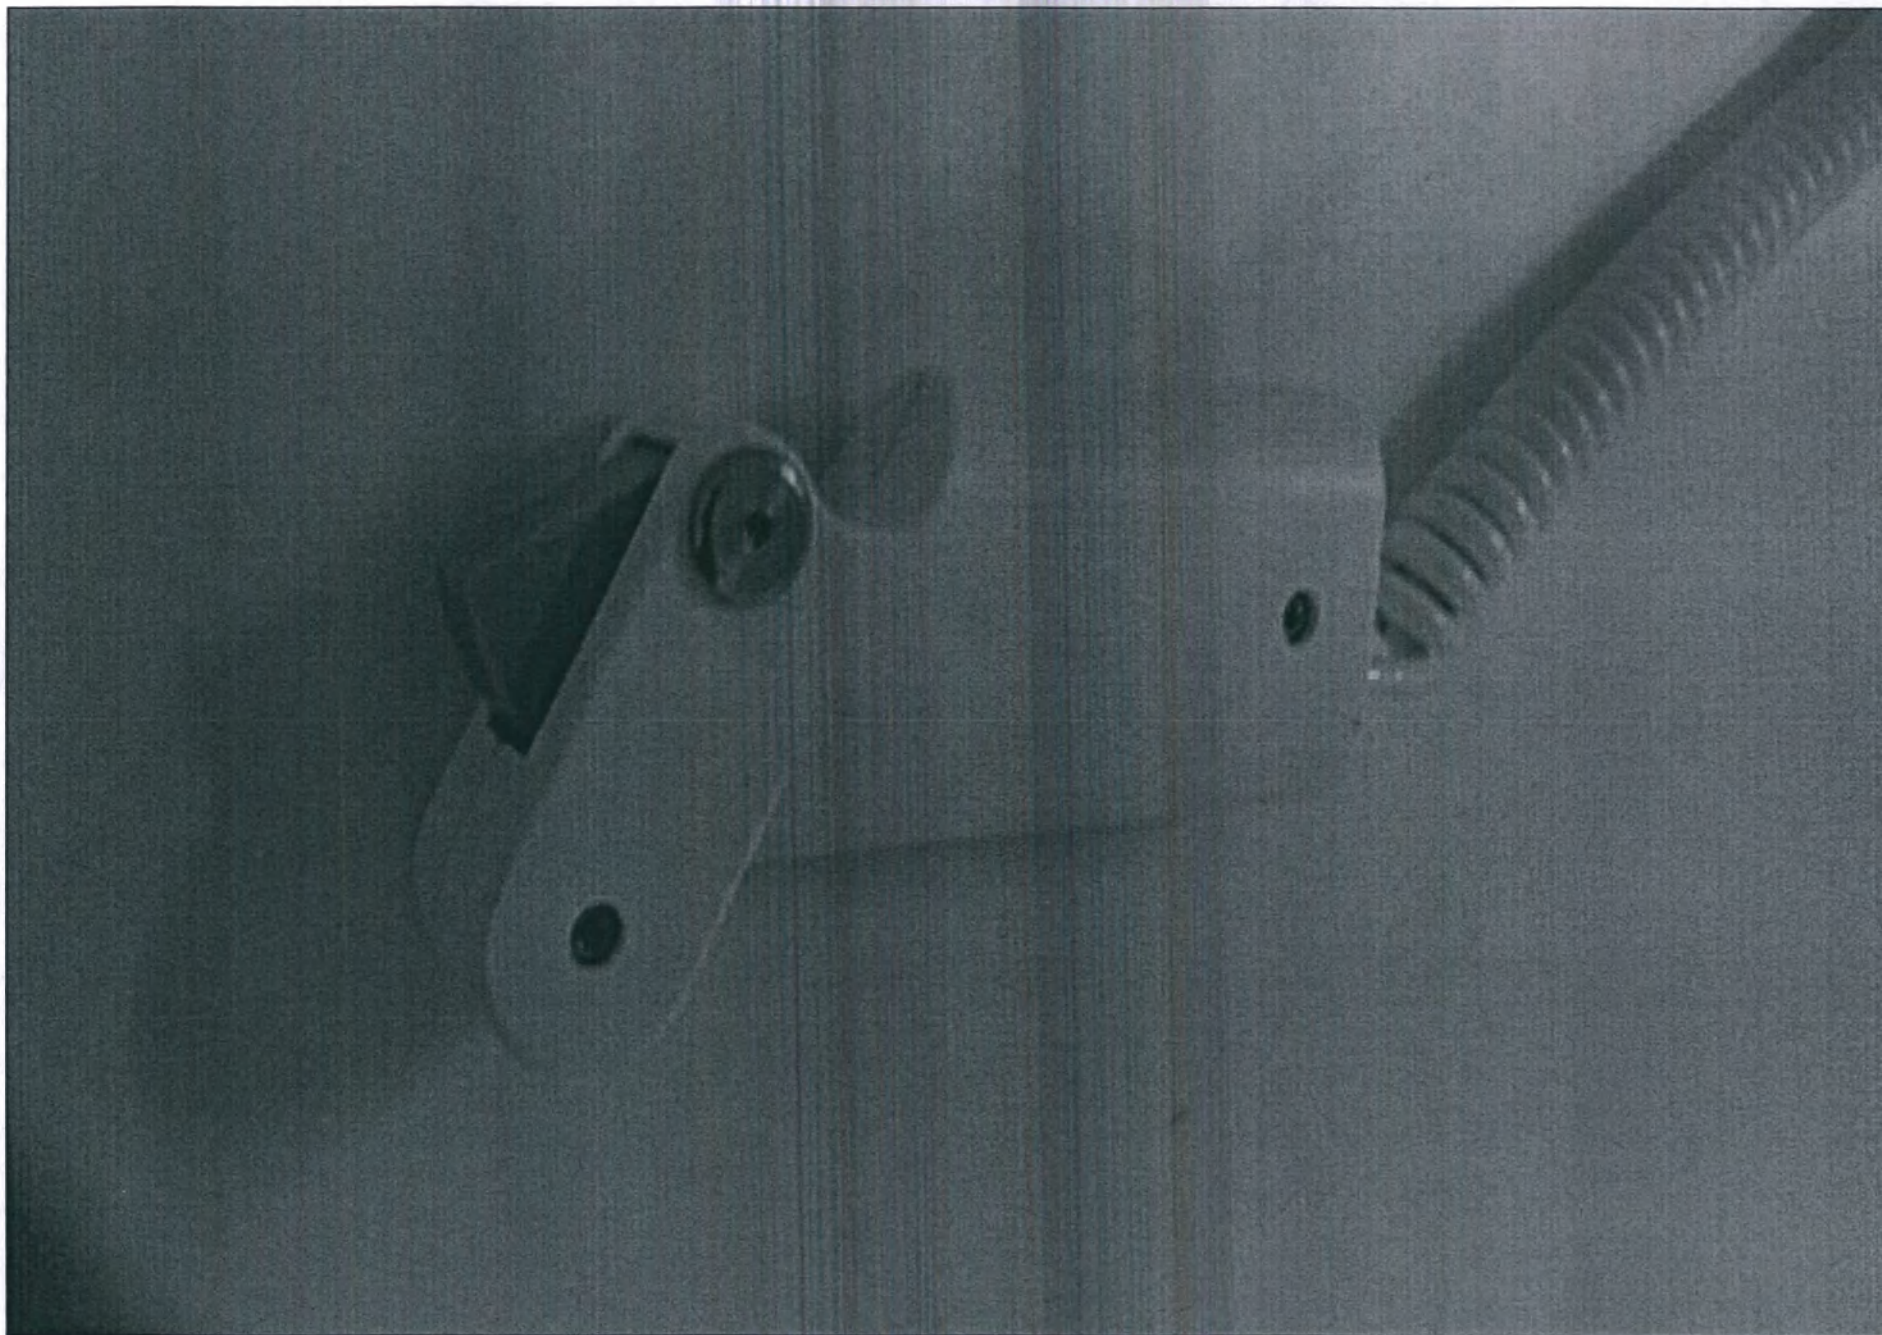


11. Регулятор скорости.




12. Ручной переключатель экспозиции.

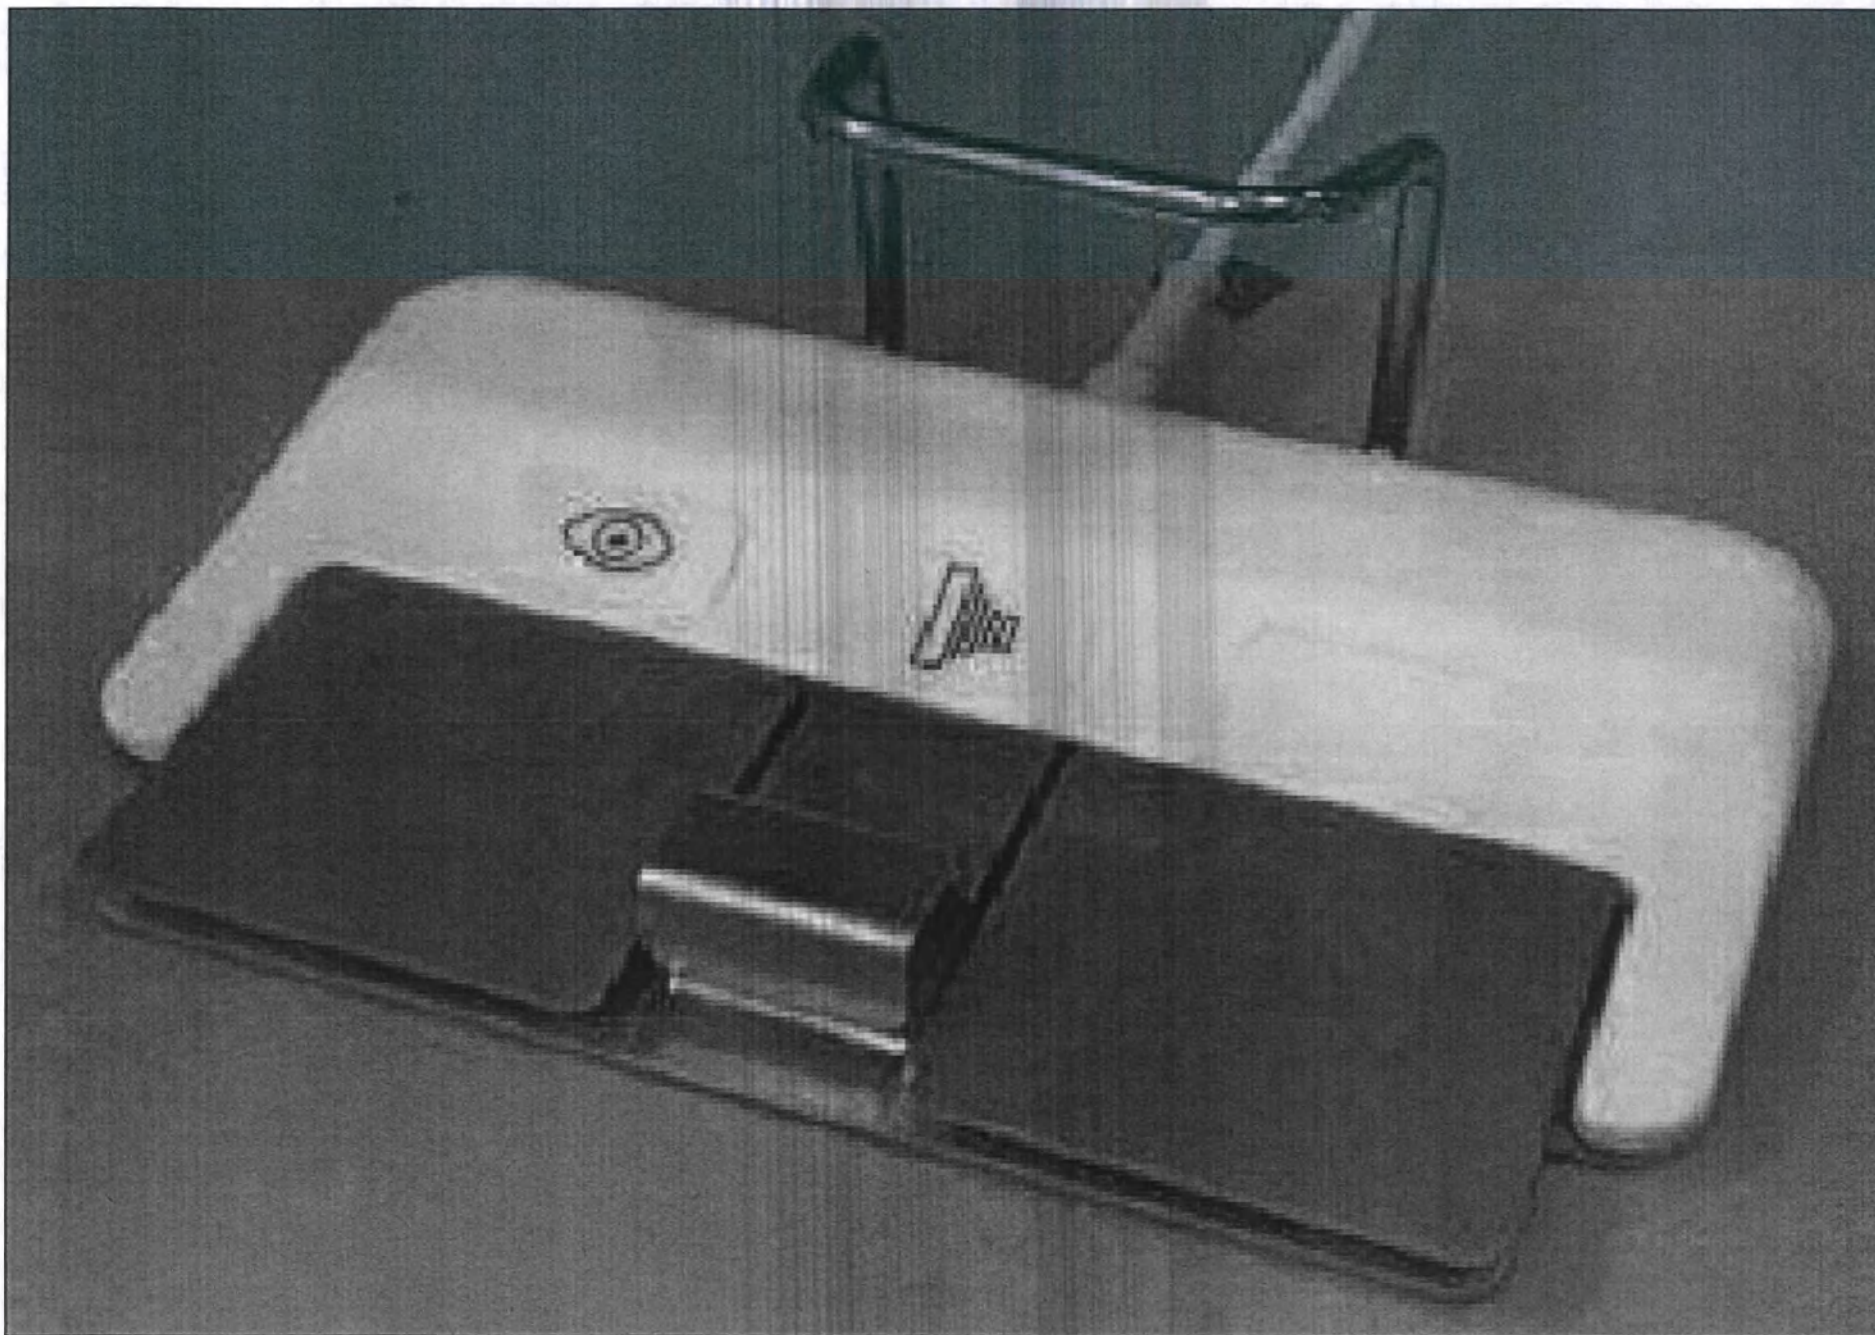


13. Ножной переключатель, не более 2 шт.

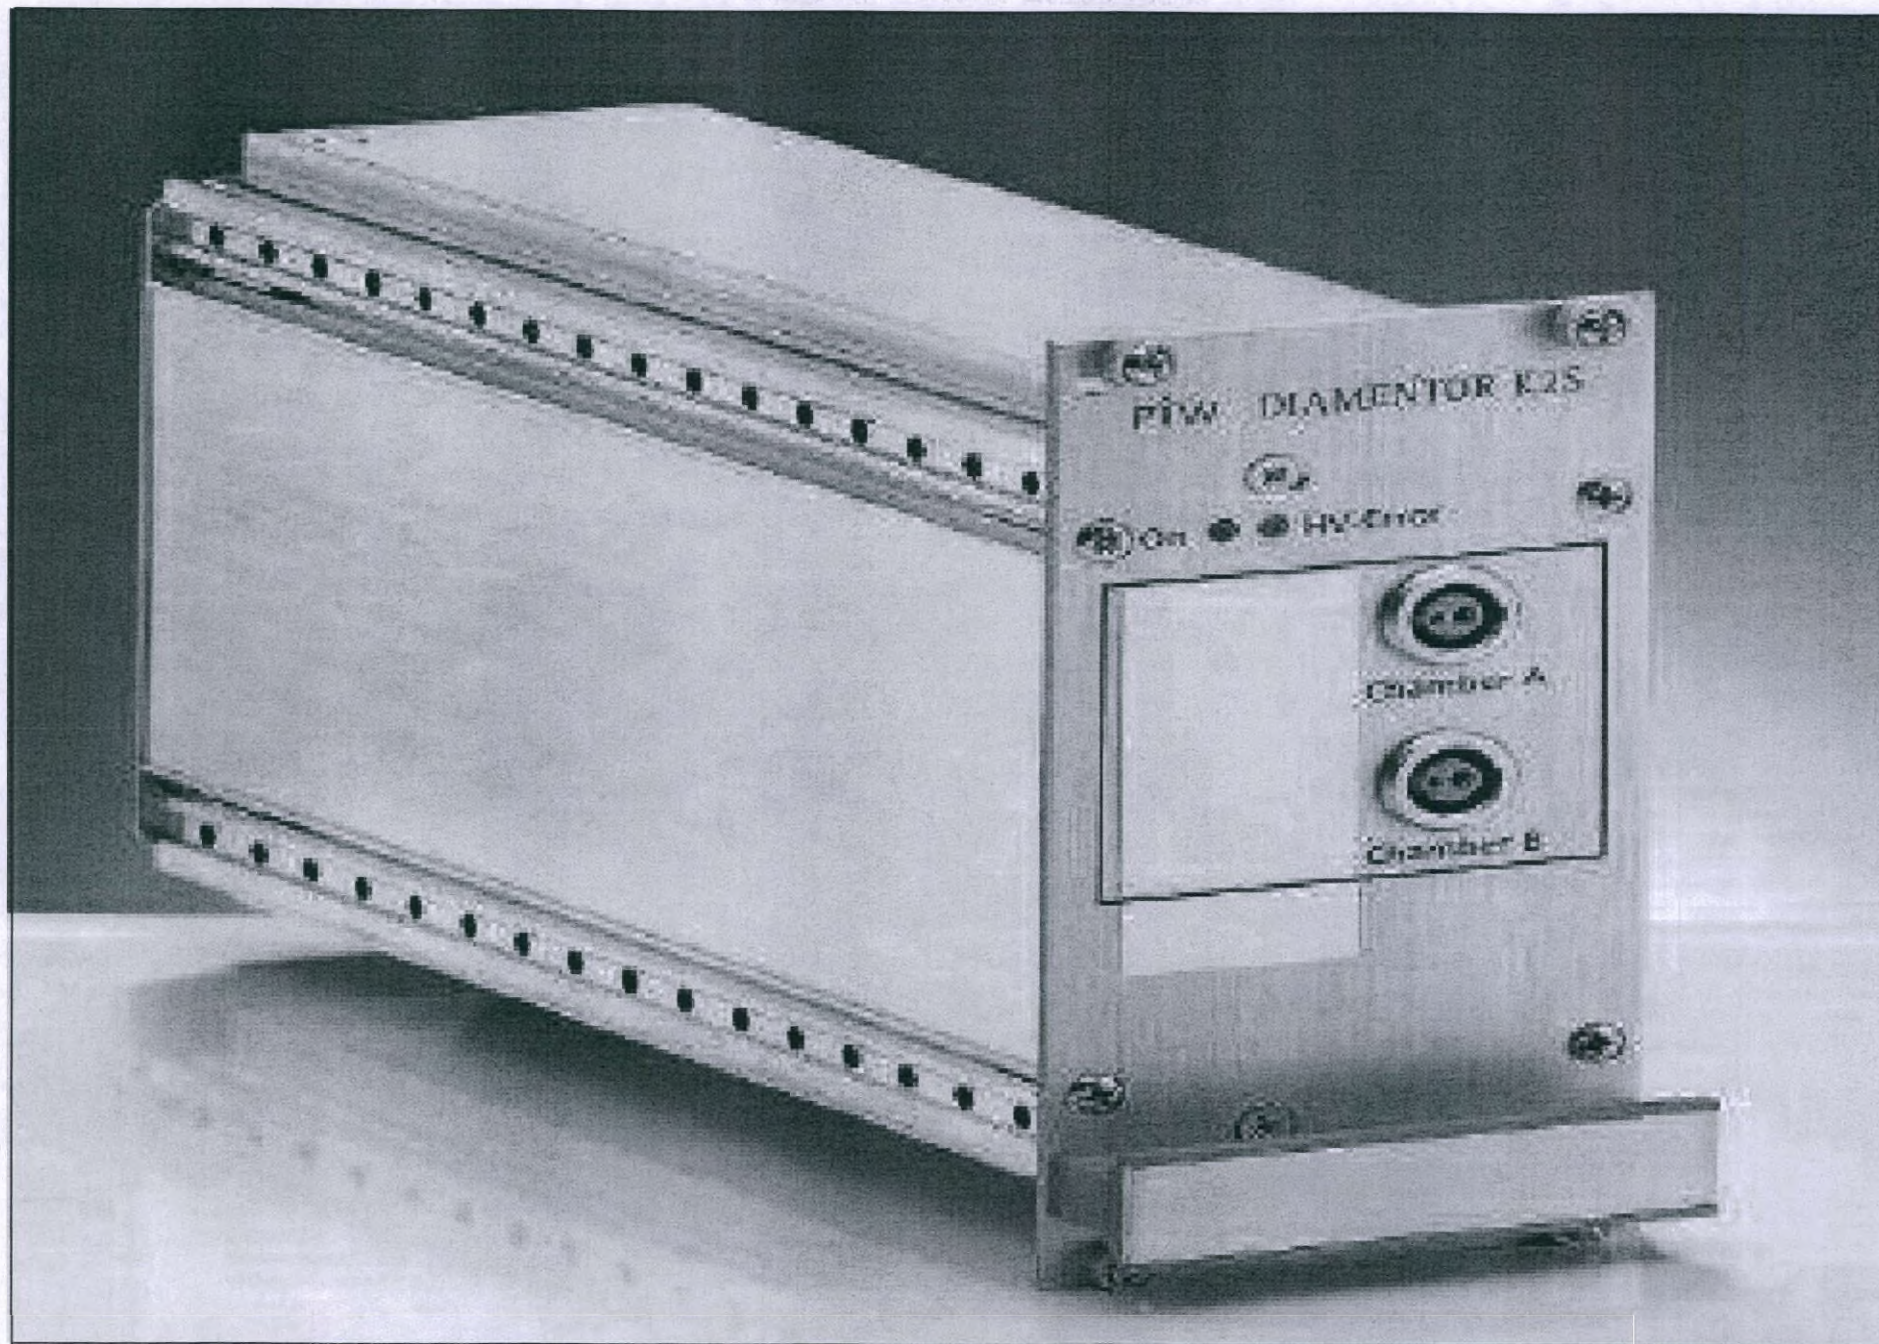


14.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

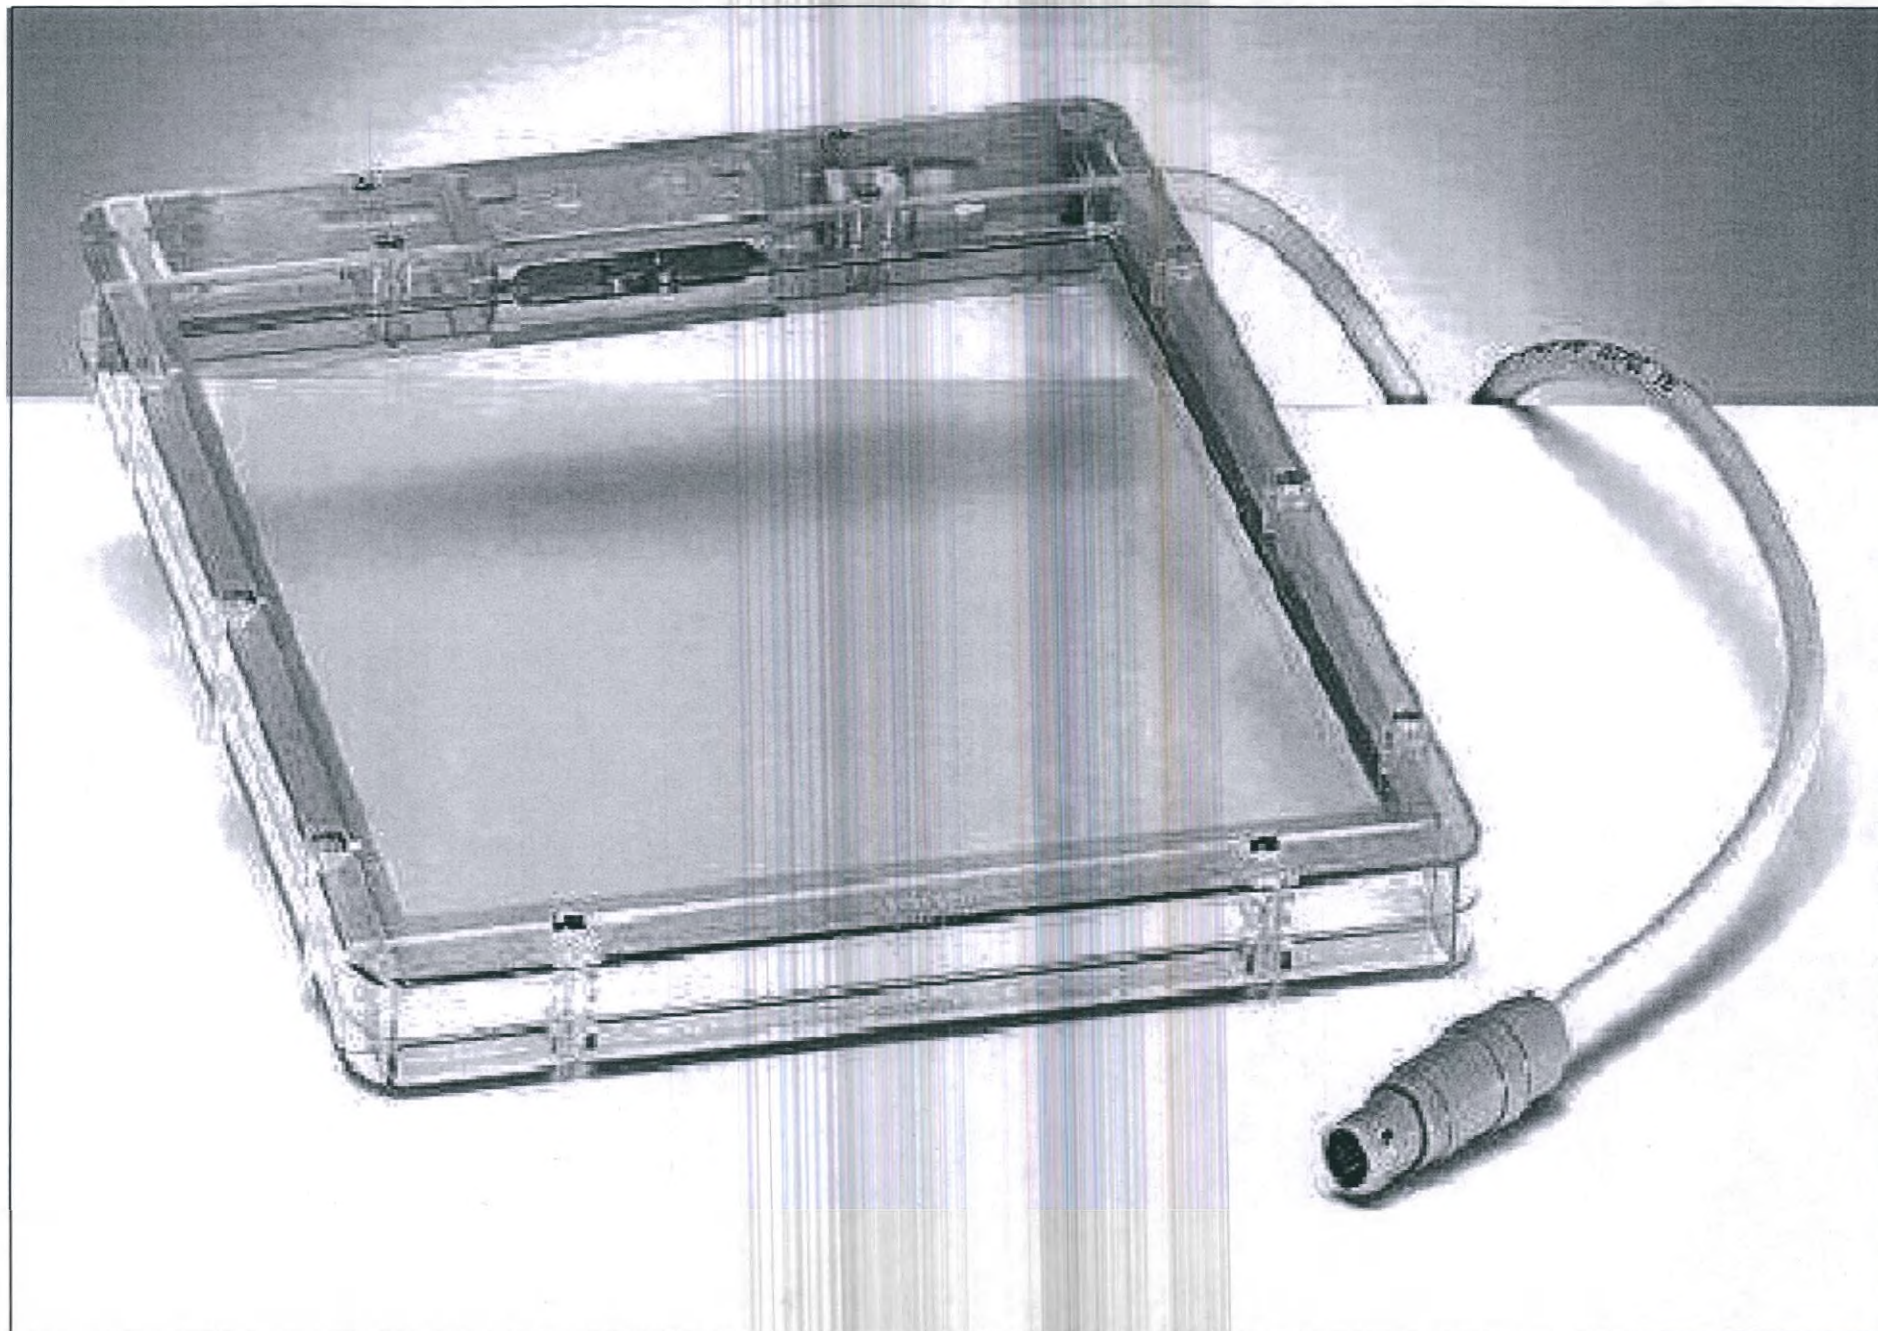


14.б. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДПК-1* или *ДПК-1М*.

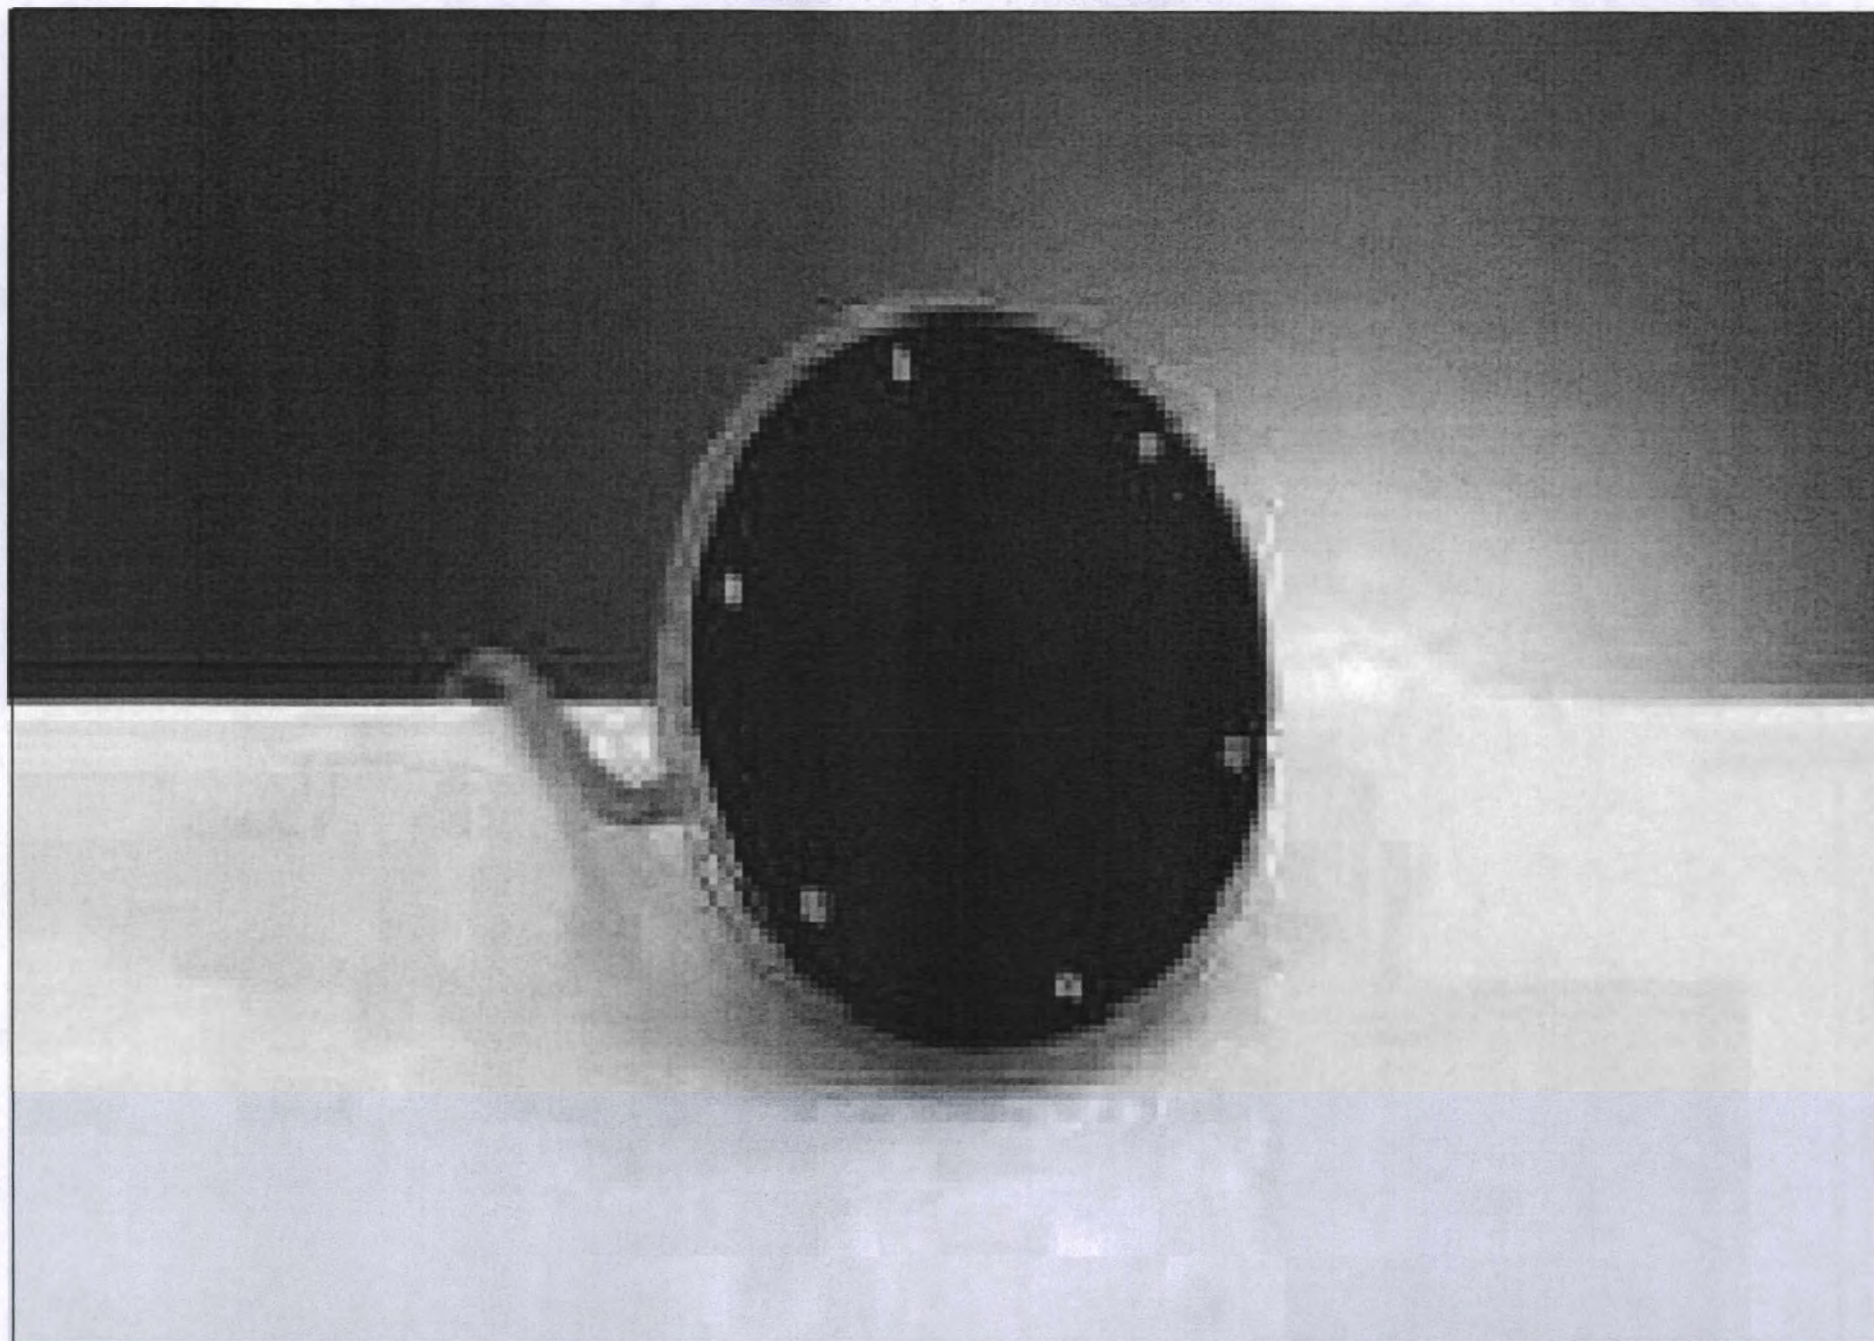


14.в. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДРК-1* или *ДРК-1М*.

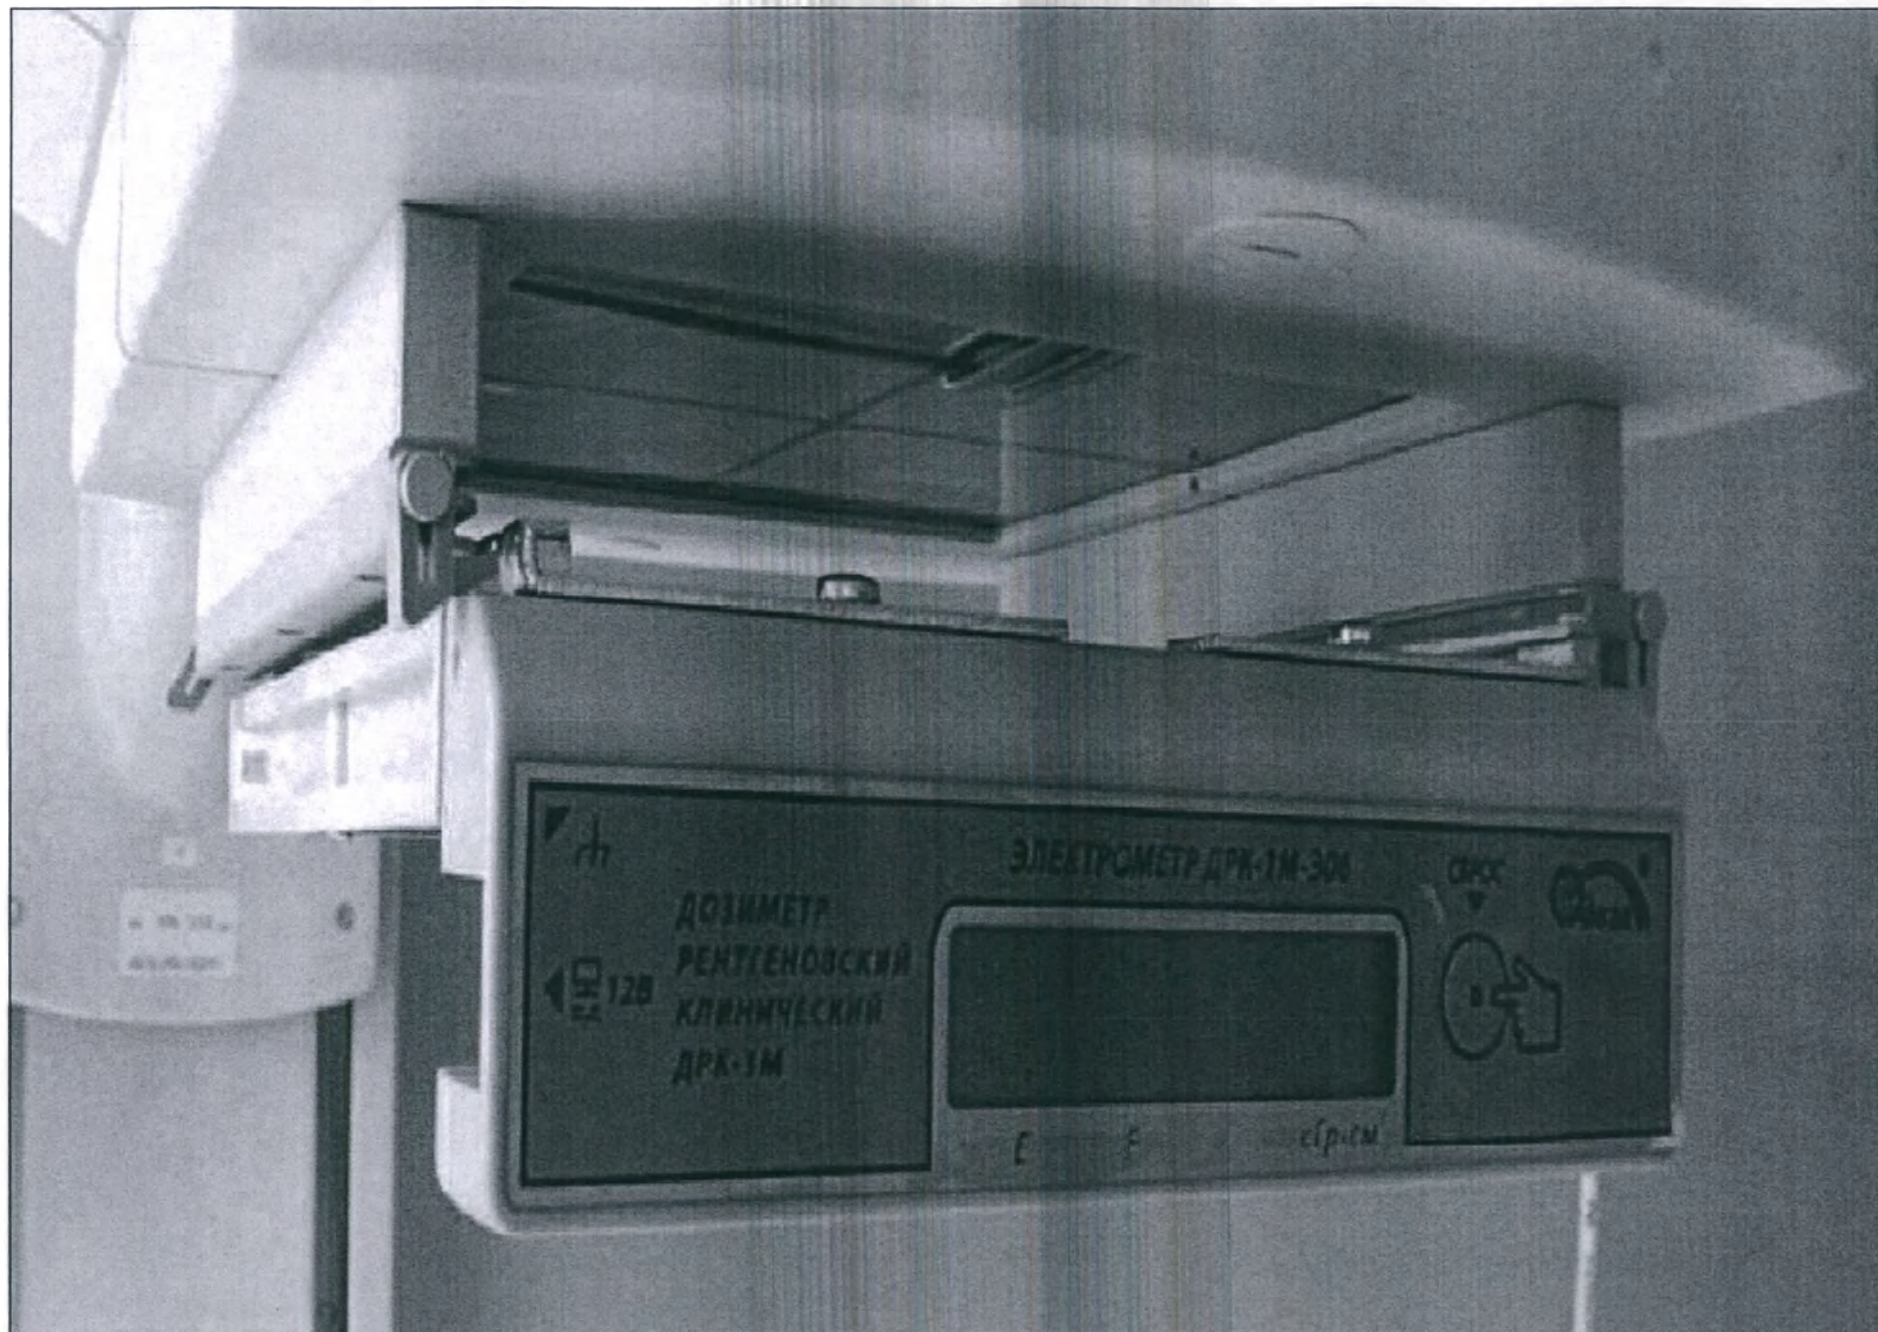


14.2. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

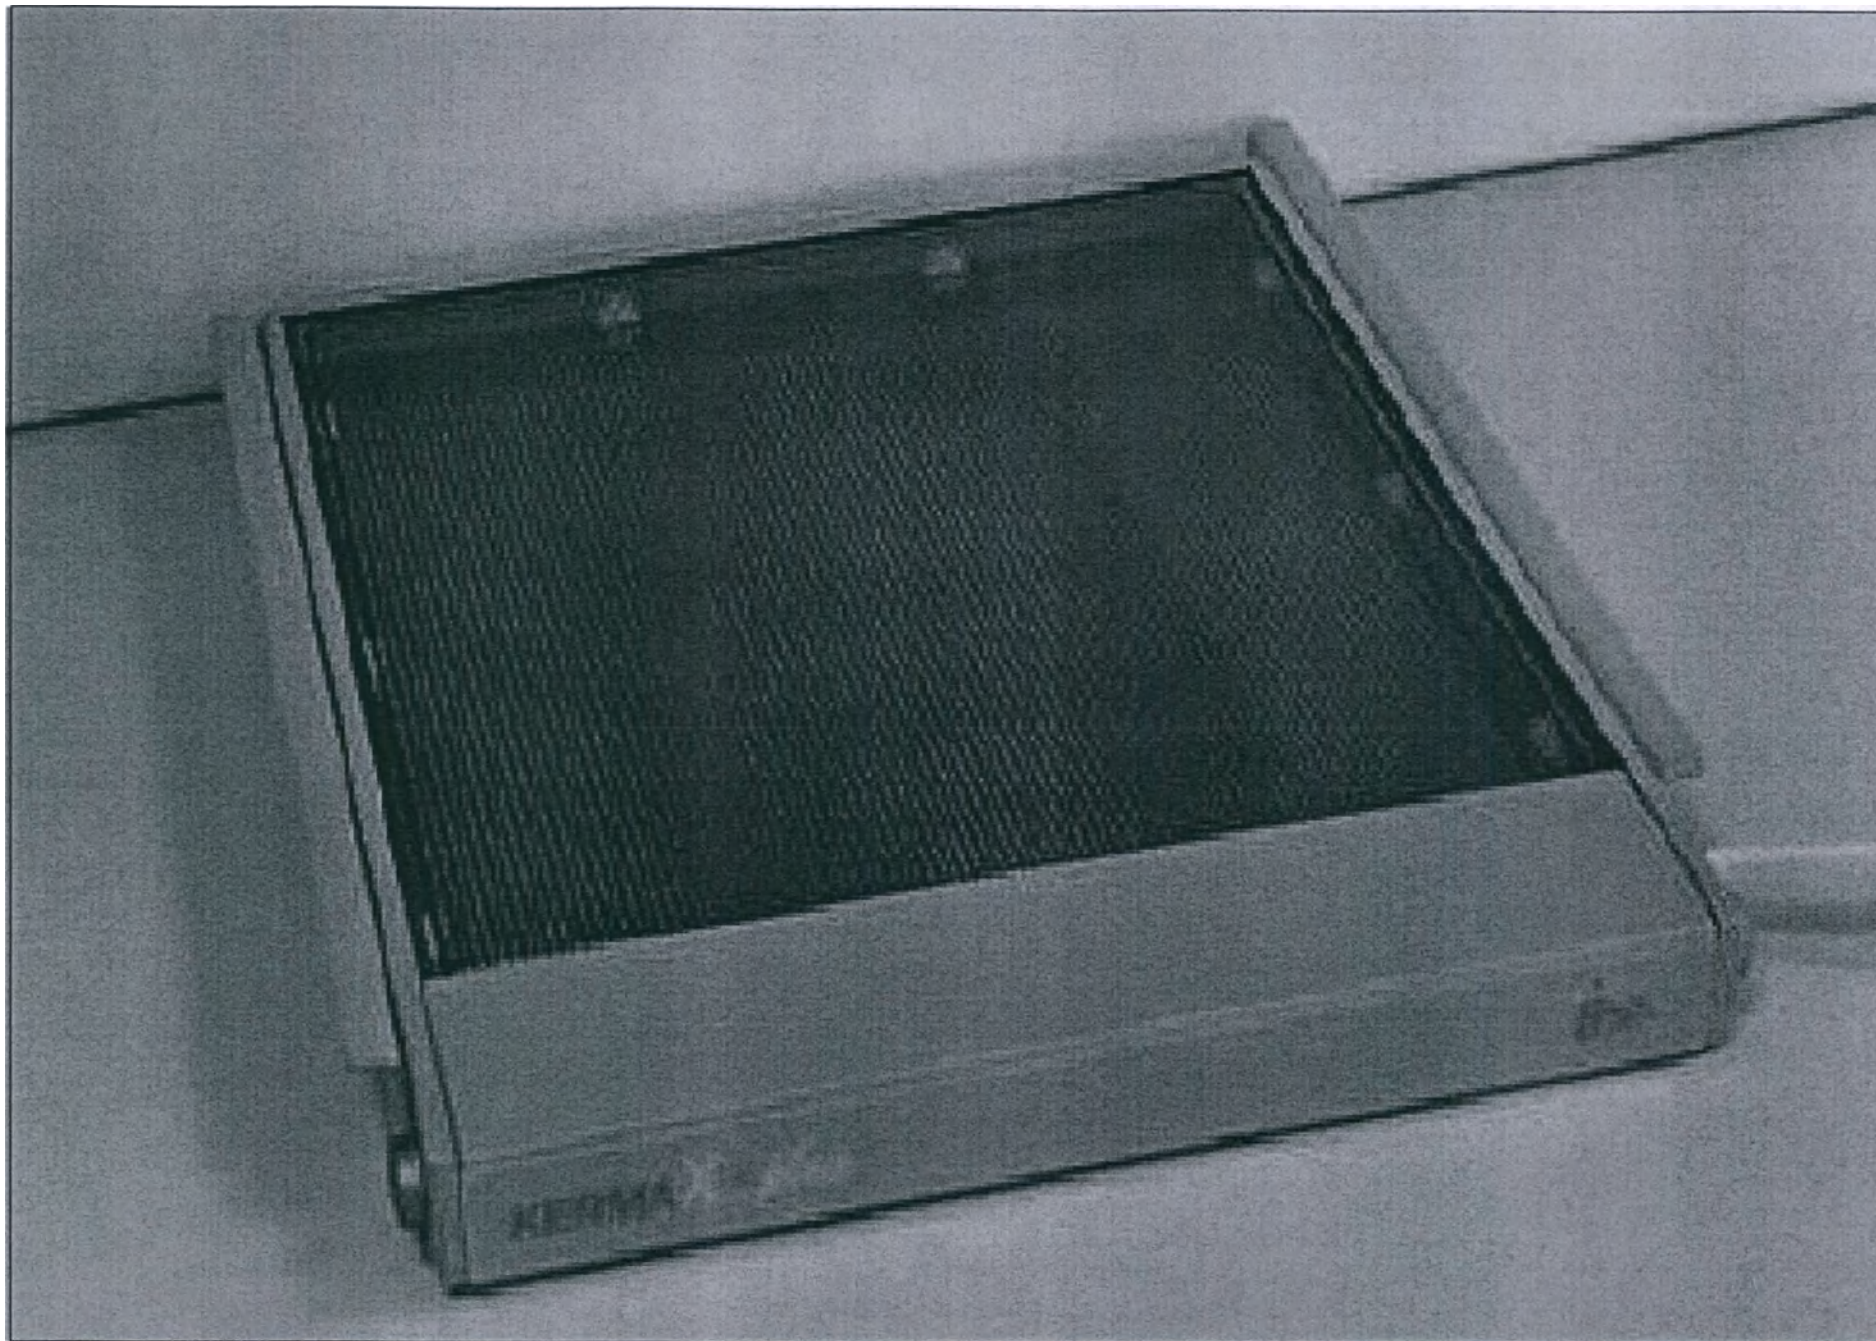


15. Измеритель производства дозы на площадь KermaX plus 120-132.

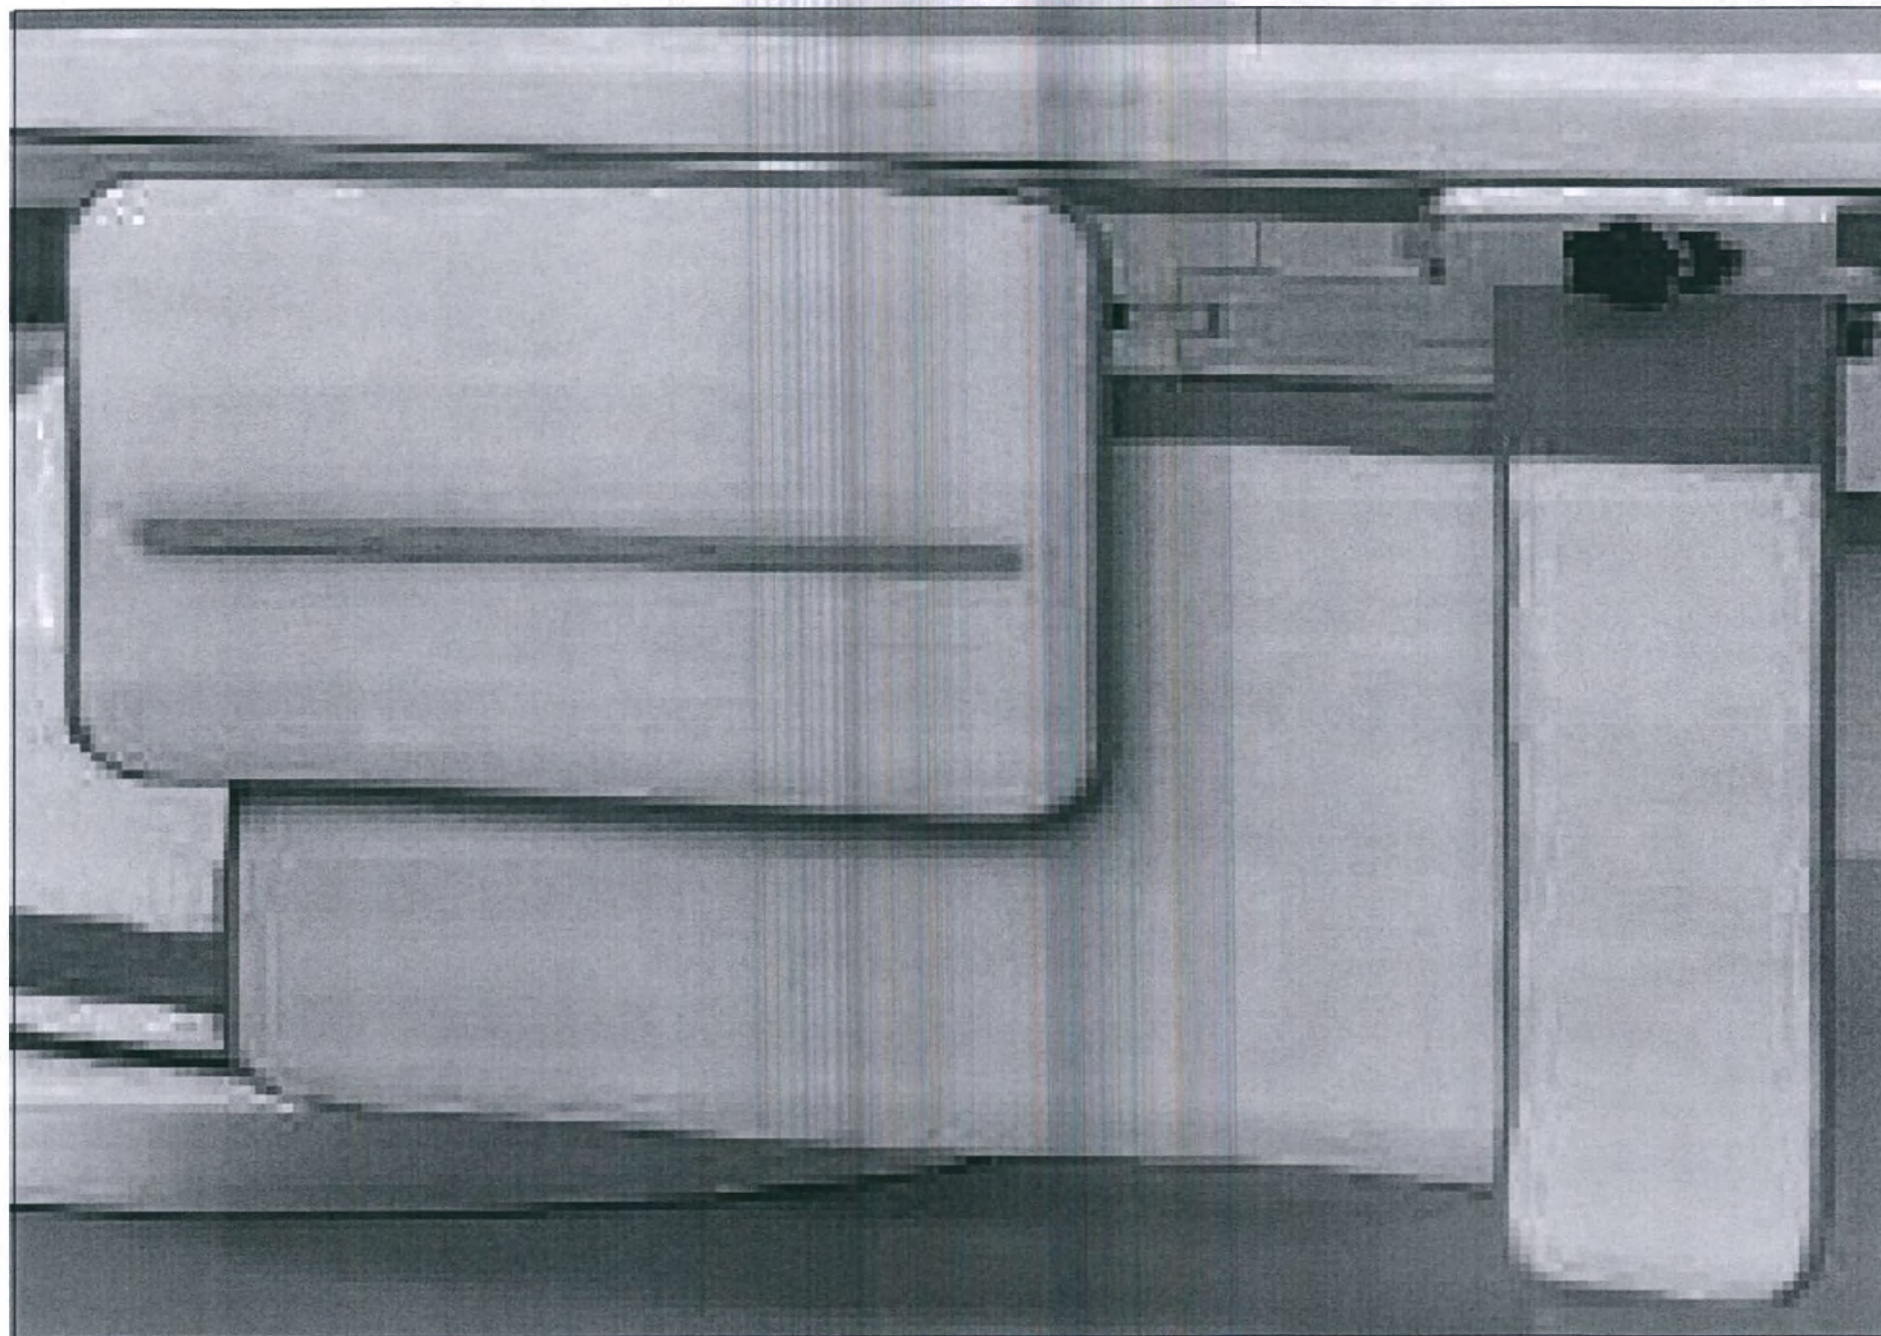


16. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

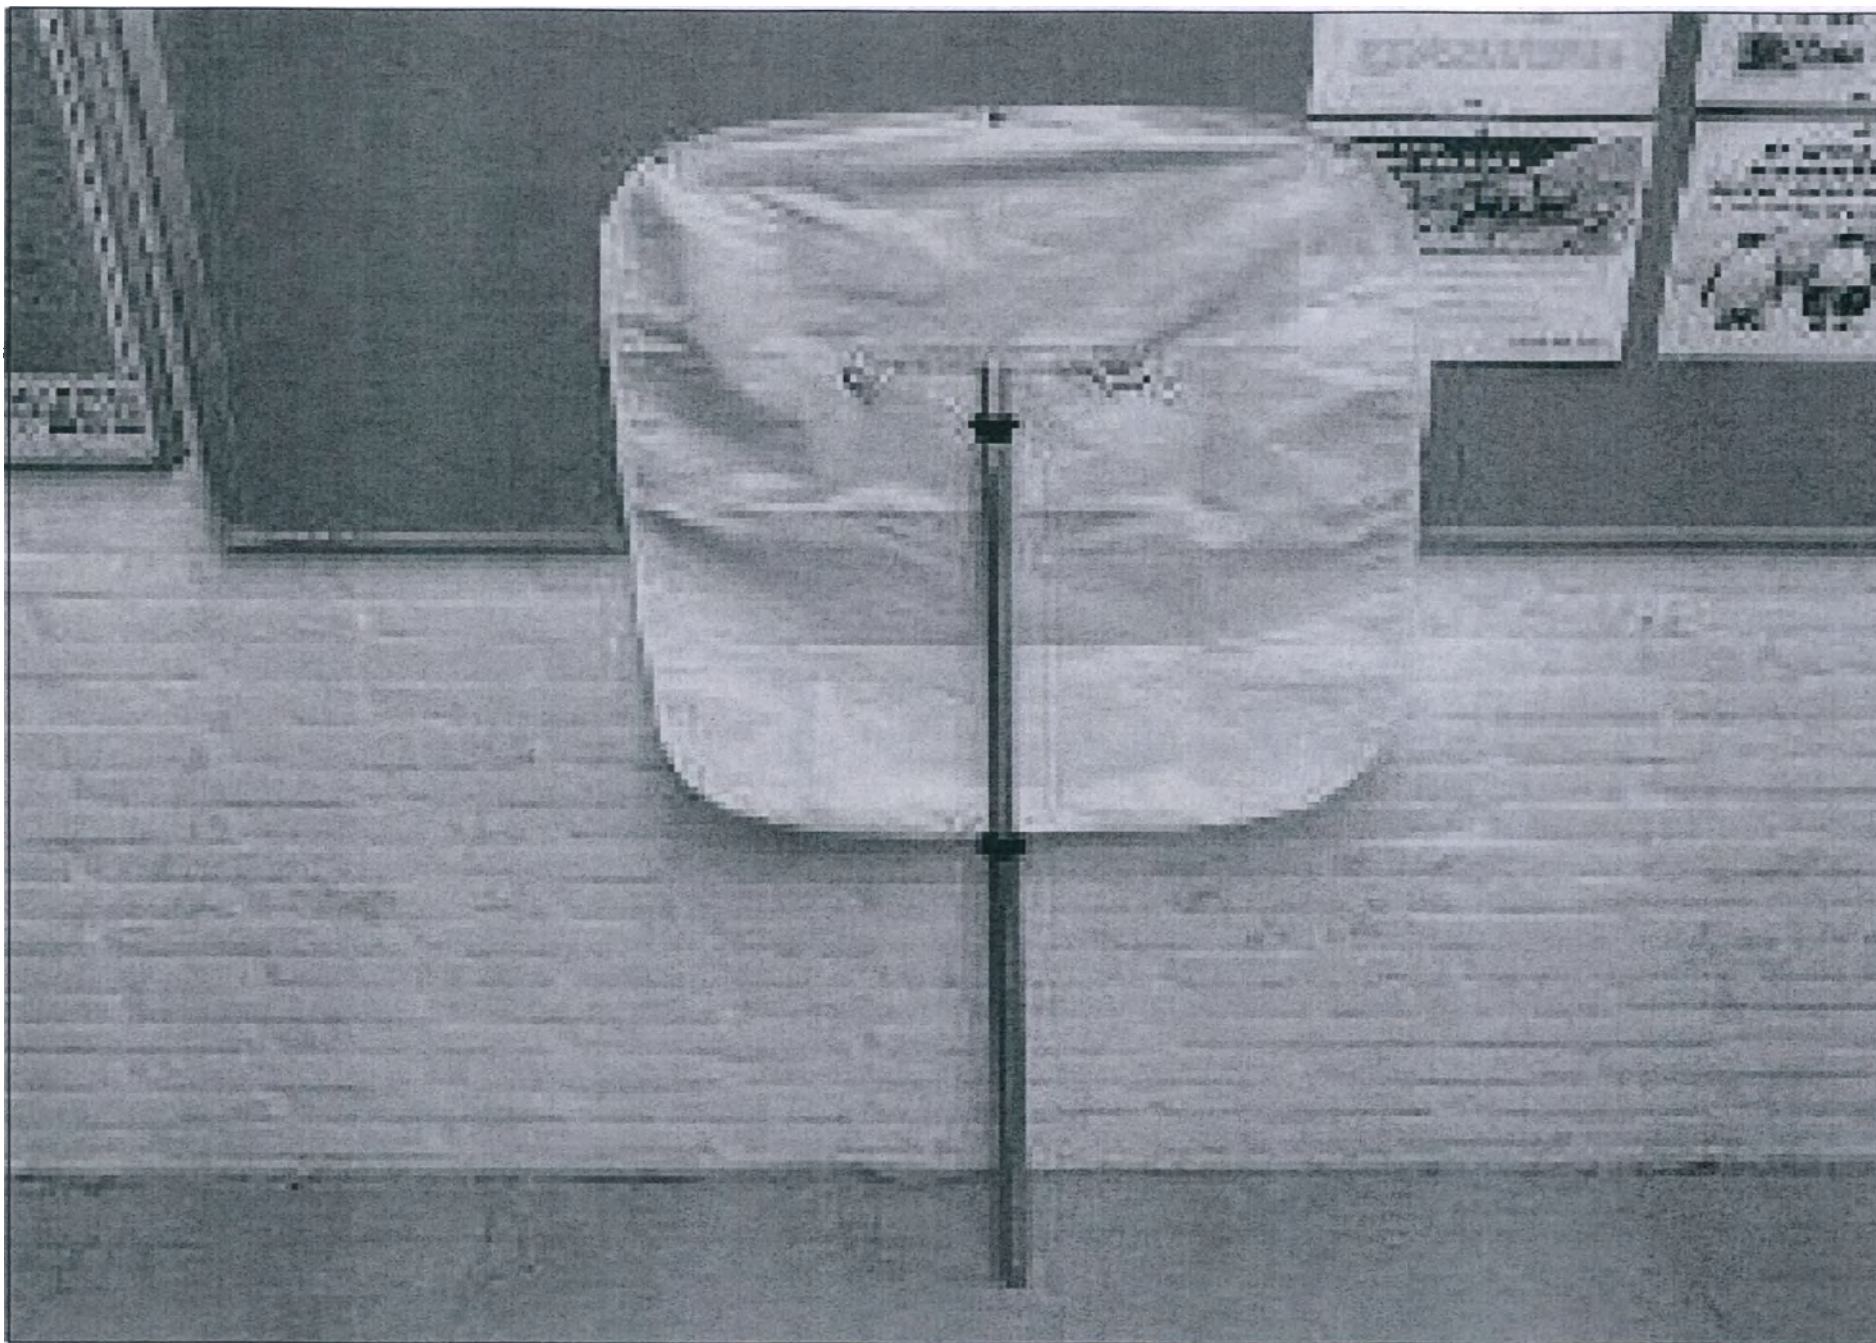


17. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

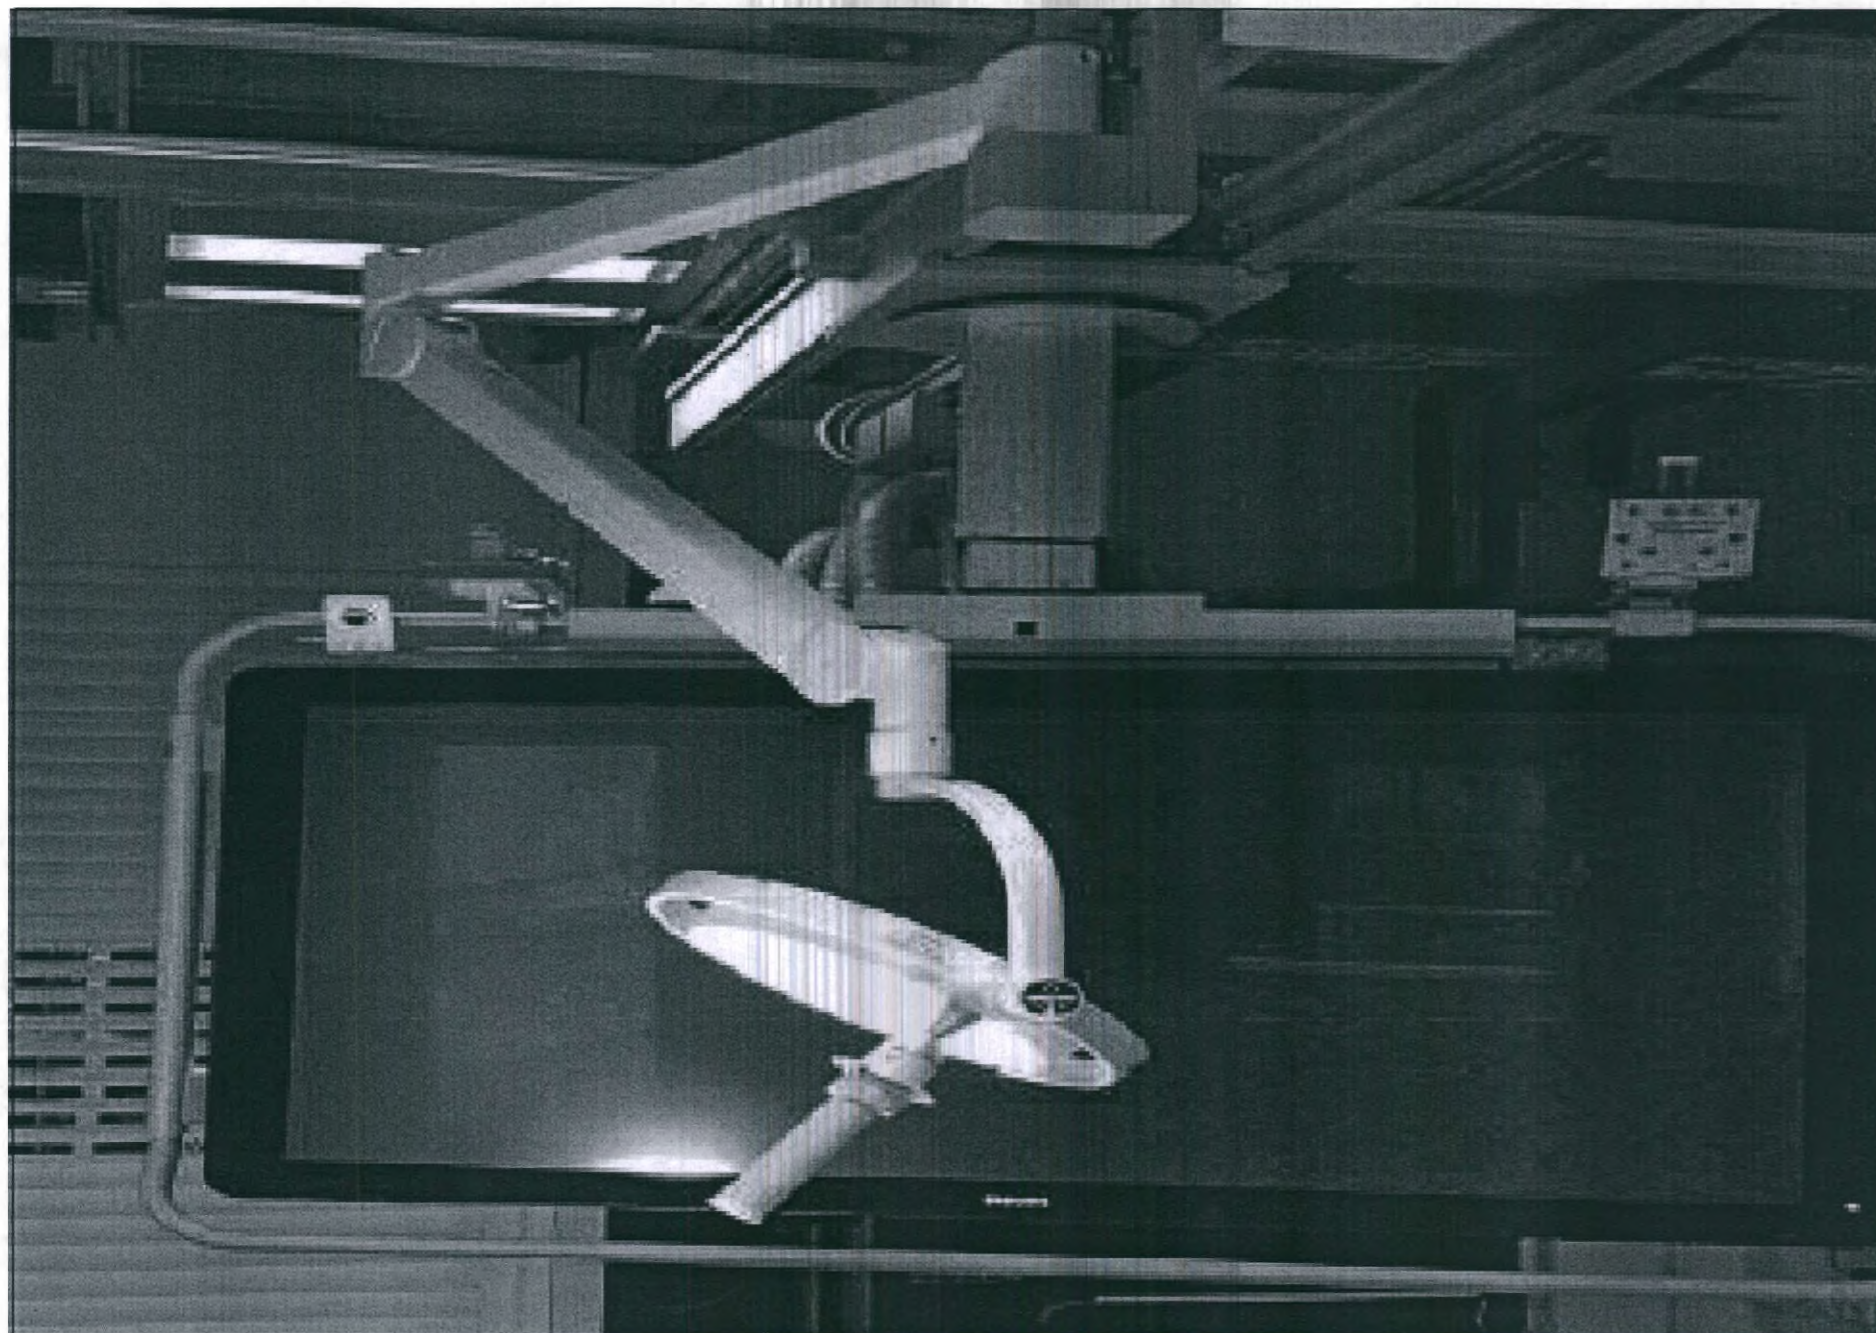

18. Лампа для осмотра

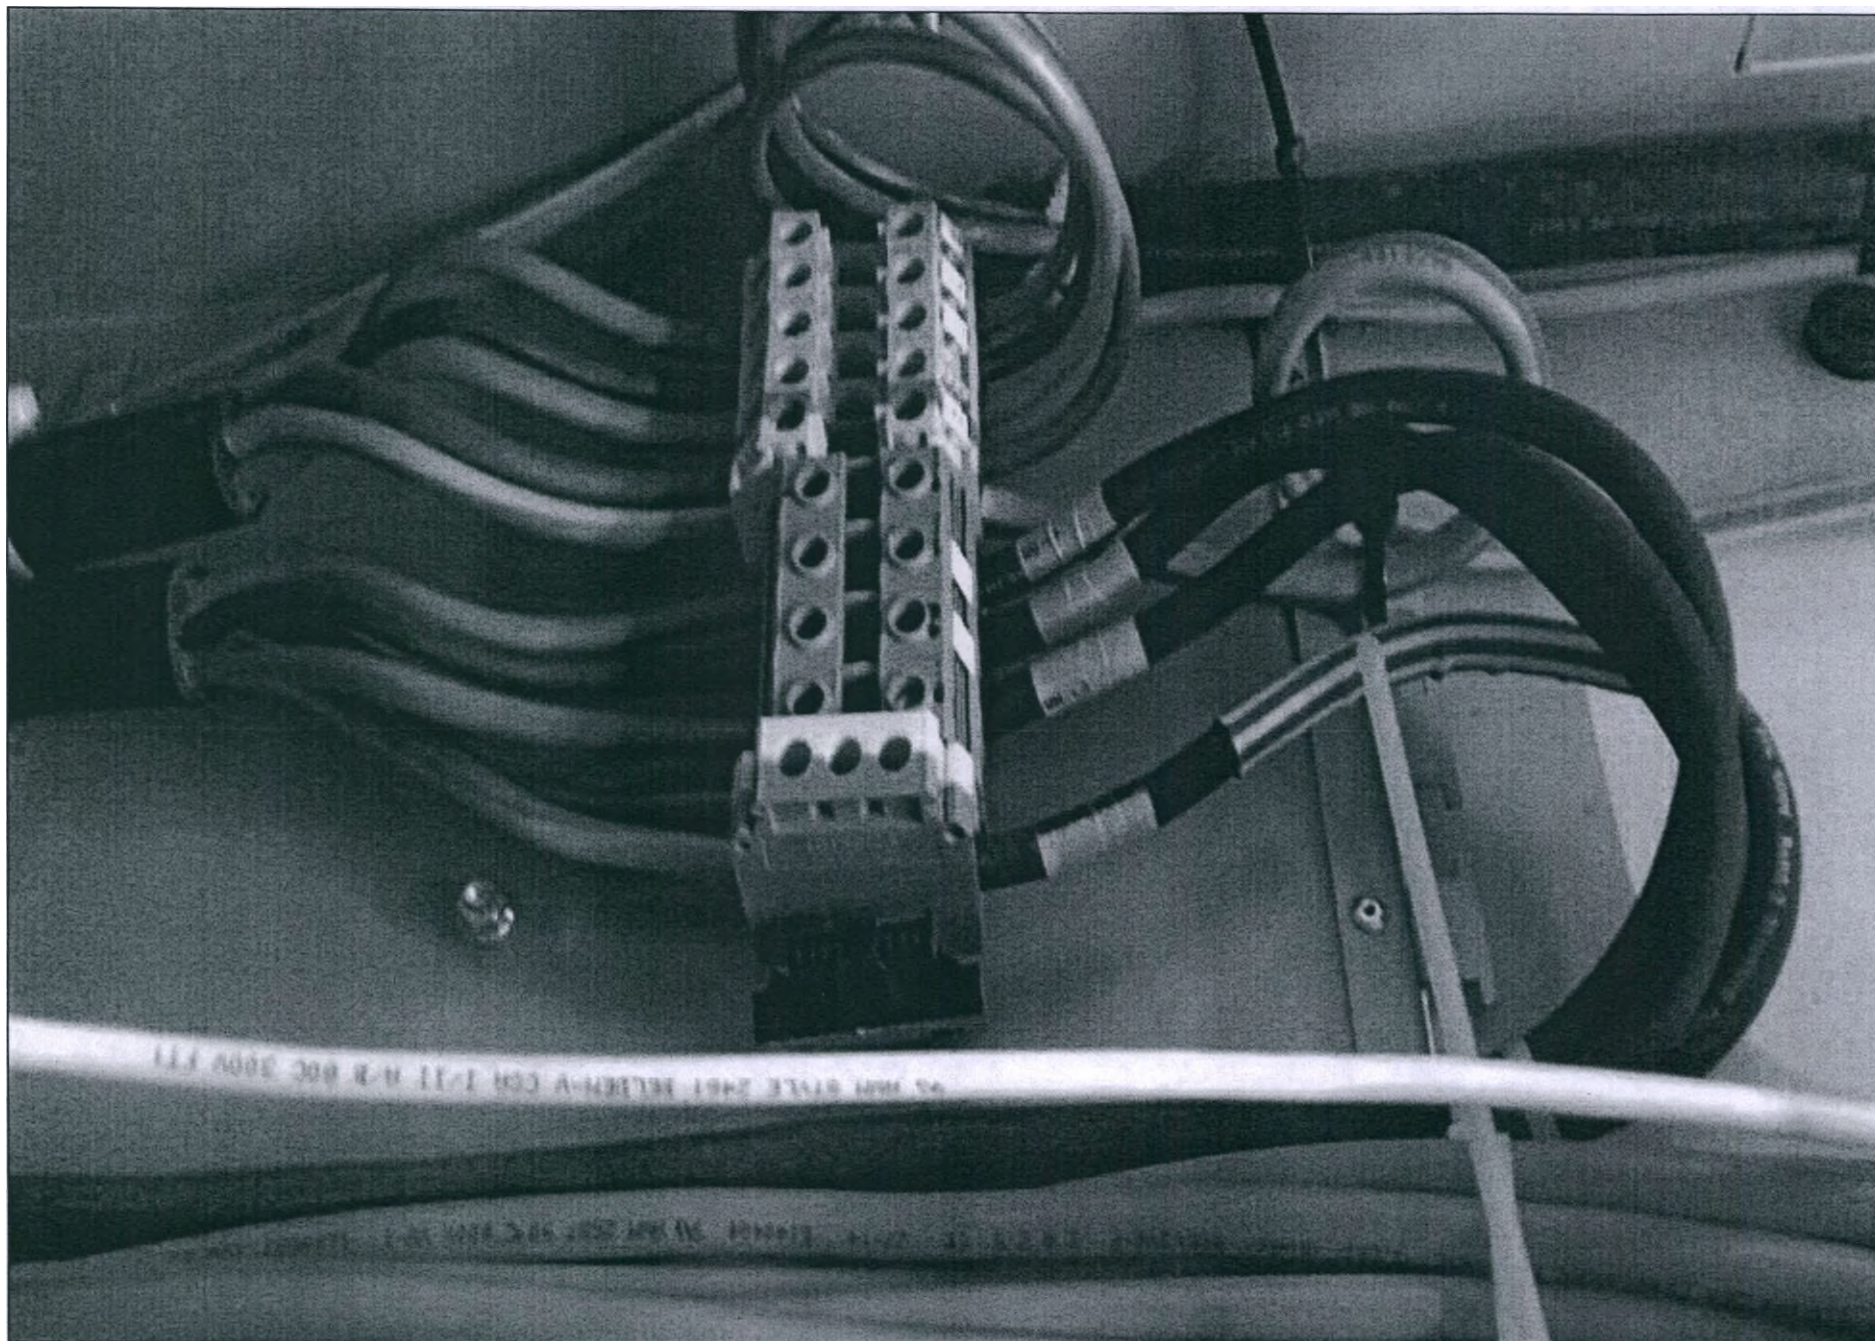

19. Кабели питания, 10 шт.

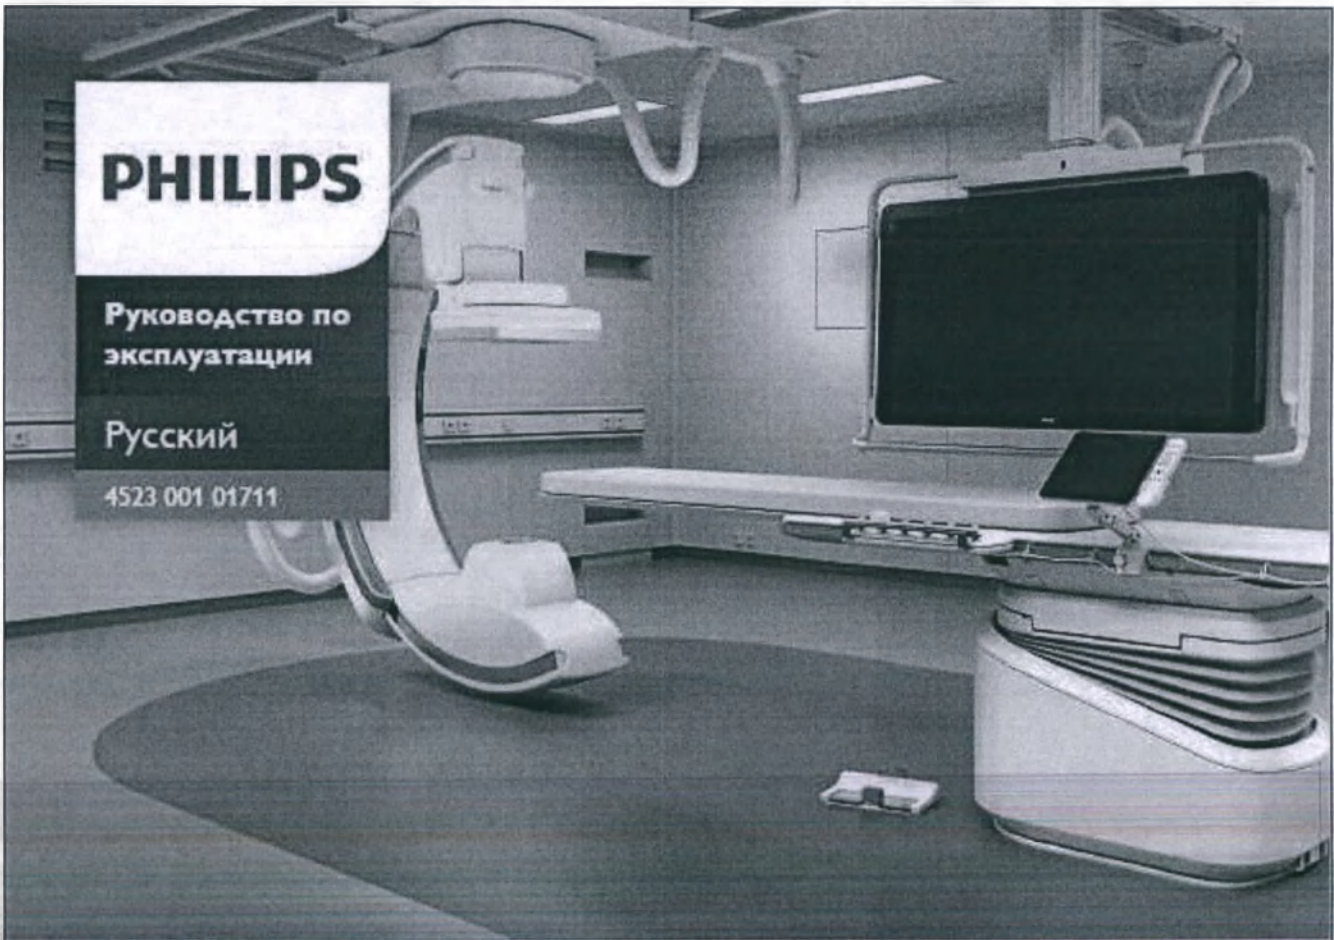A black and white photograph of a Philips Azurion medical suite. The room features a large, curved patient table, a large monitor mounted on a stand, and a C-arm X-ray machine. The Philips logo is visible in the top left corner of the image.

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский

4523 001 01711

Philips Azurion


Версия 2.2

20.. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


21. Система хирургической навигации с дополненной реальностью ClarifEye, в составе:



21.1.a. Рабочая станция ClarifEye: - системный блок с программным приложением для системы дополненной реальности ClarifEye версия 1.0 и выше; - цветной монитор с диагональю 24 дюйма; - клавиатура; - мышь.

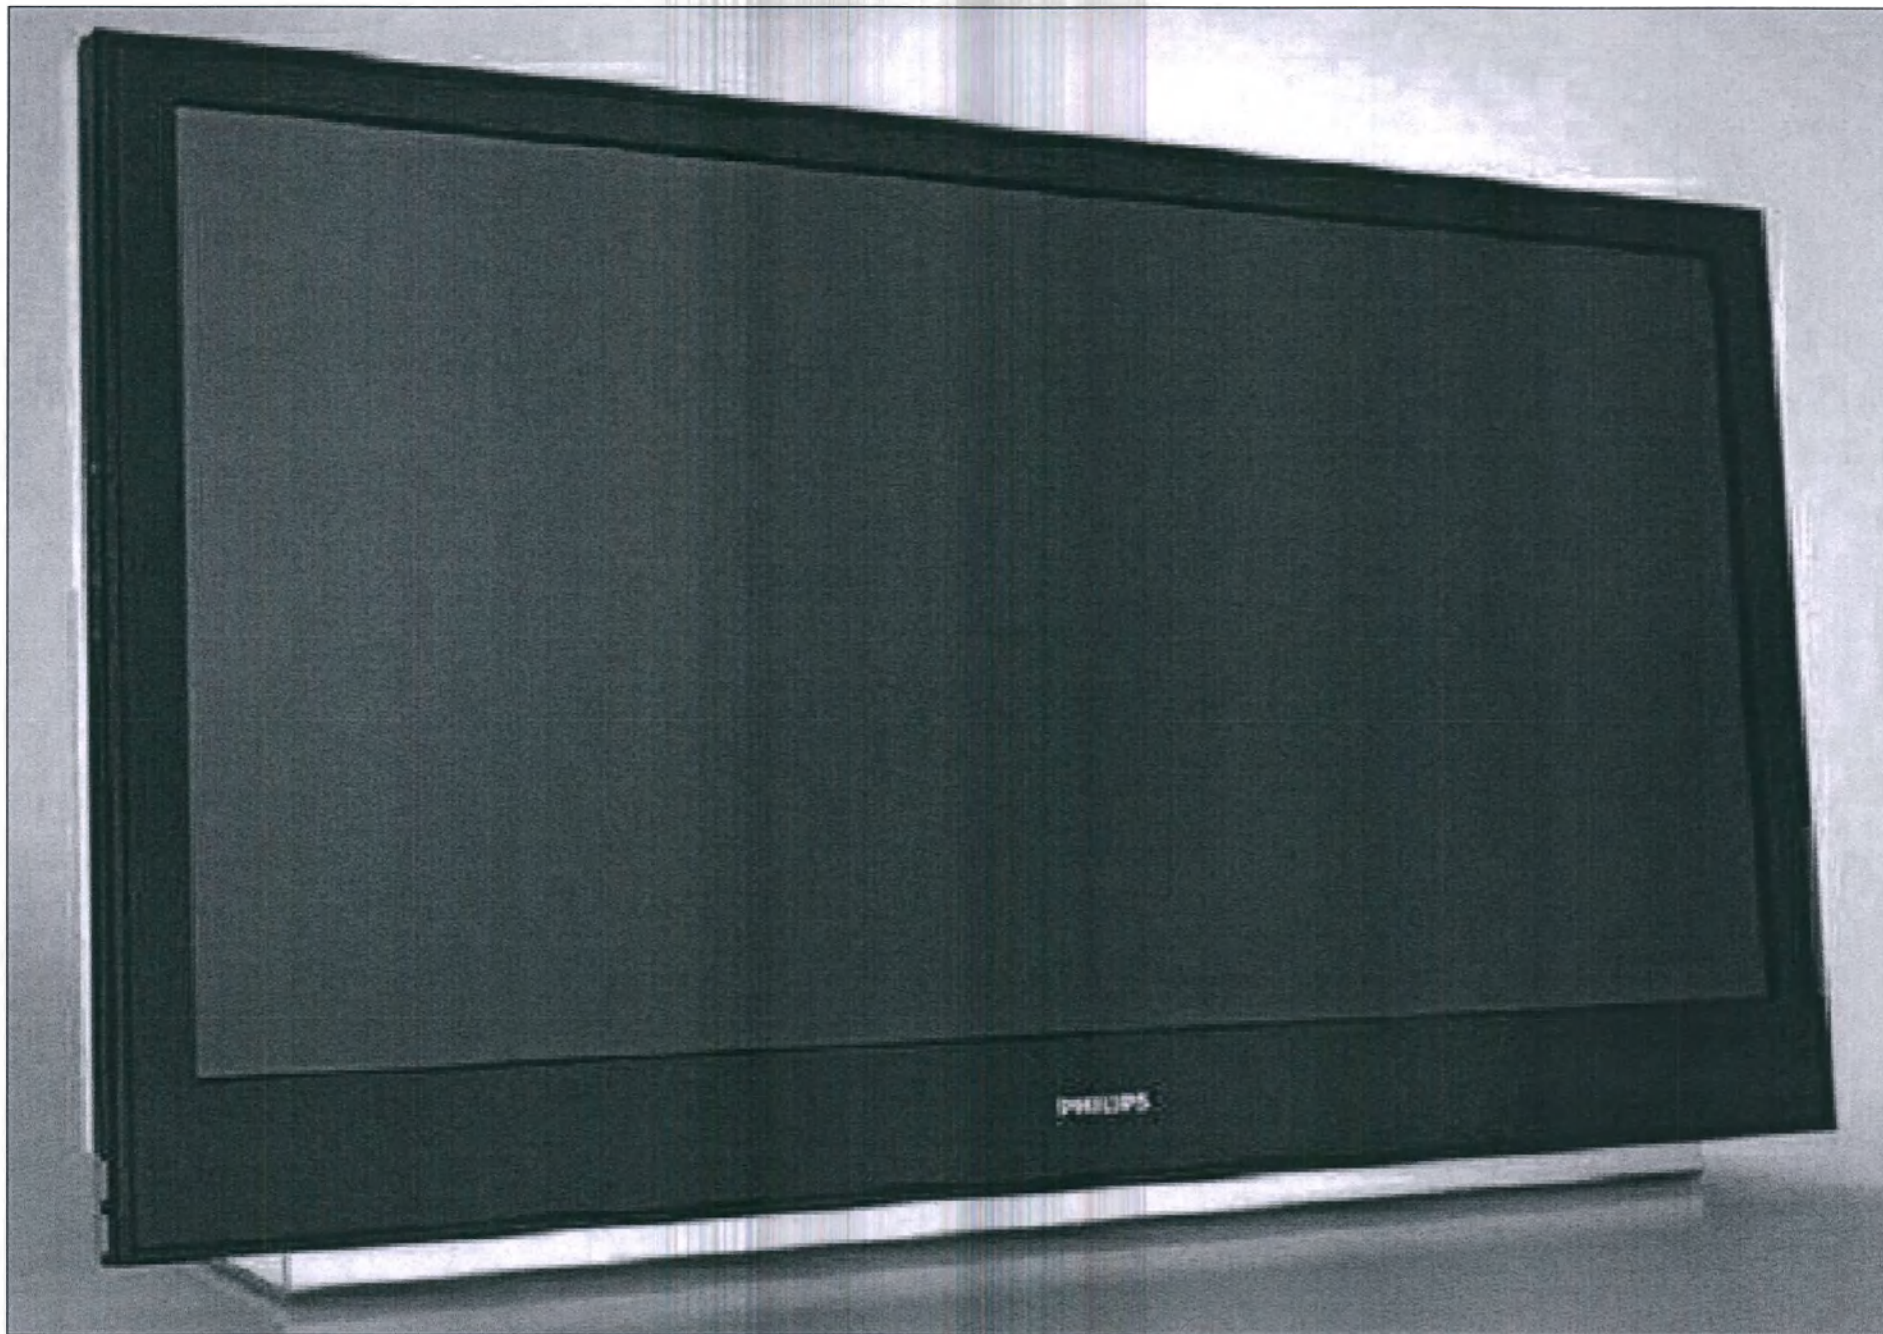

22.1.6. Рабочая станция ClarifEye: - системный блок с программным приложением для системы дополненной реальности ClarifEye версия 1.0 и выше; - цветной монитор с диагональю 24 дюйма; - клавиатура; - мышь.

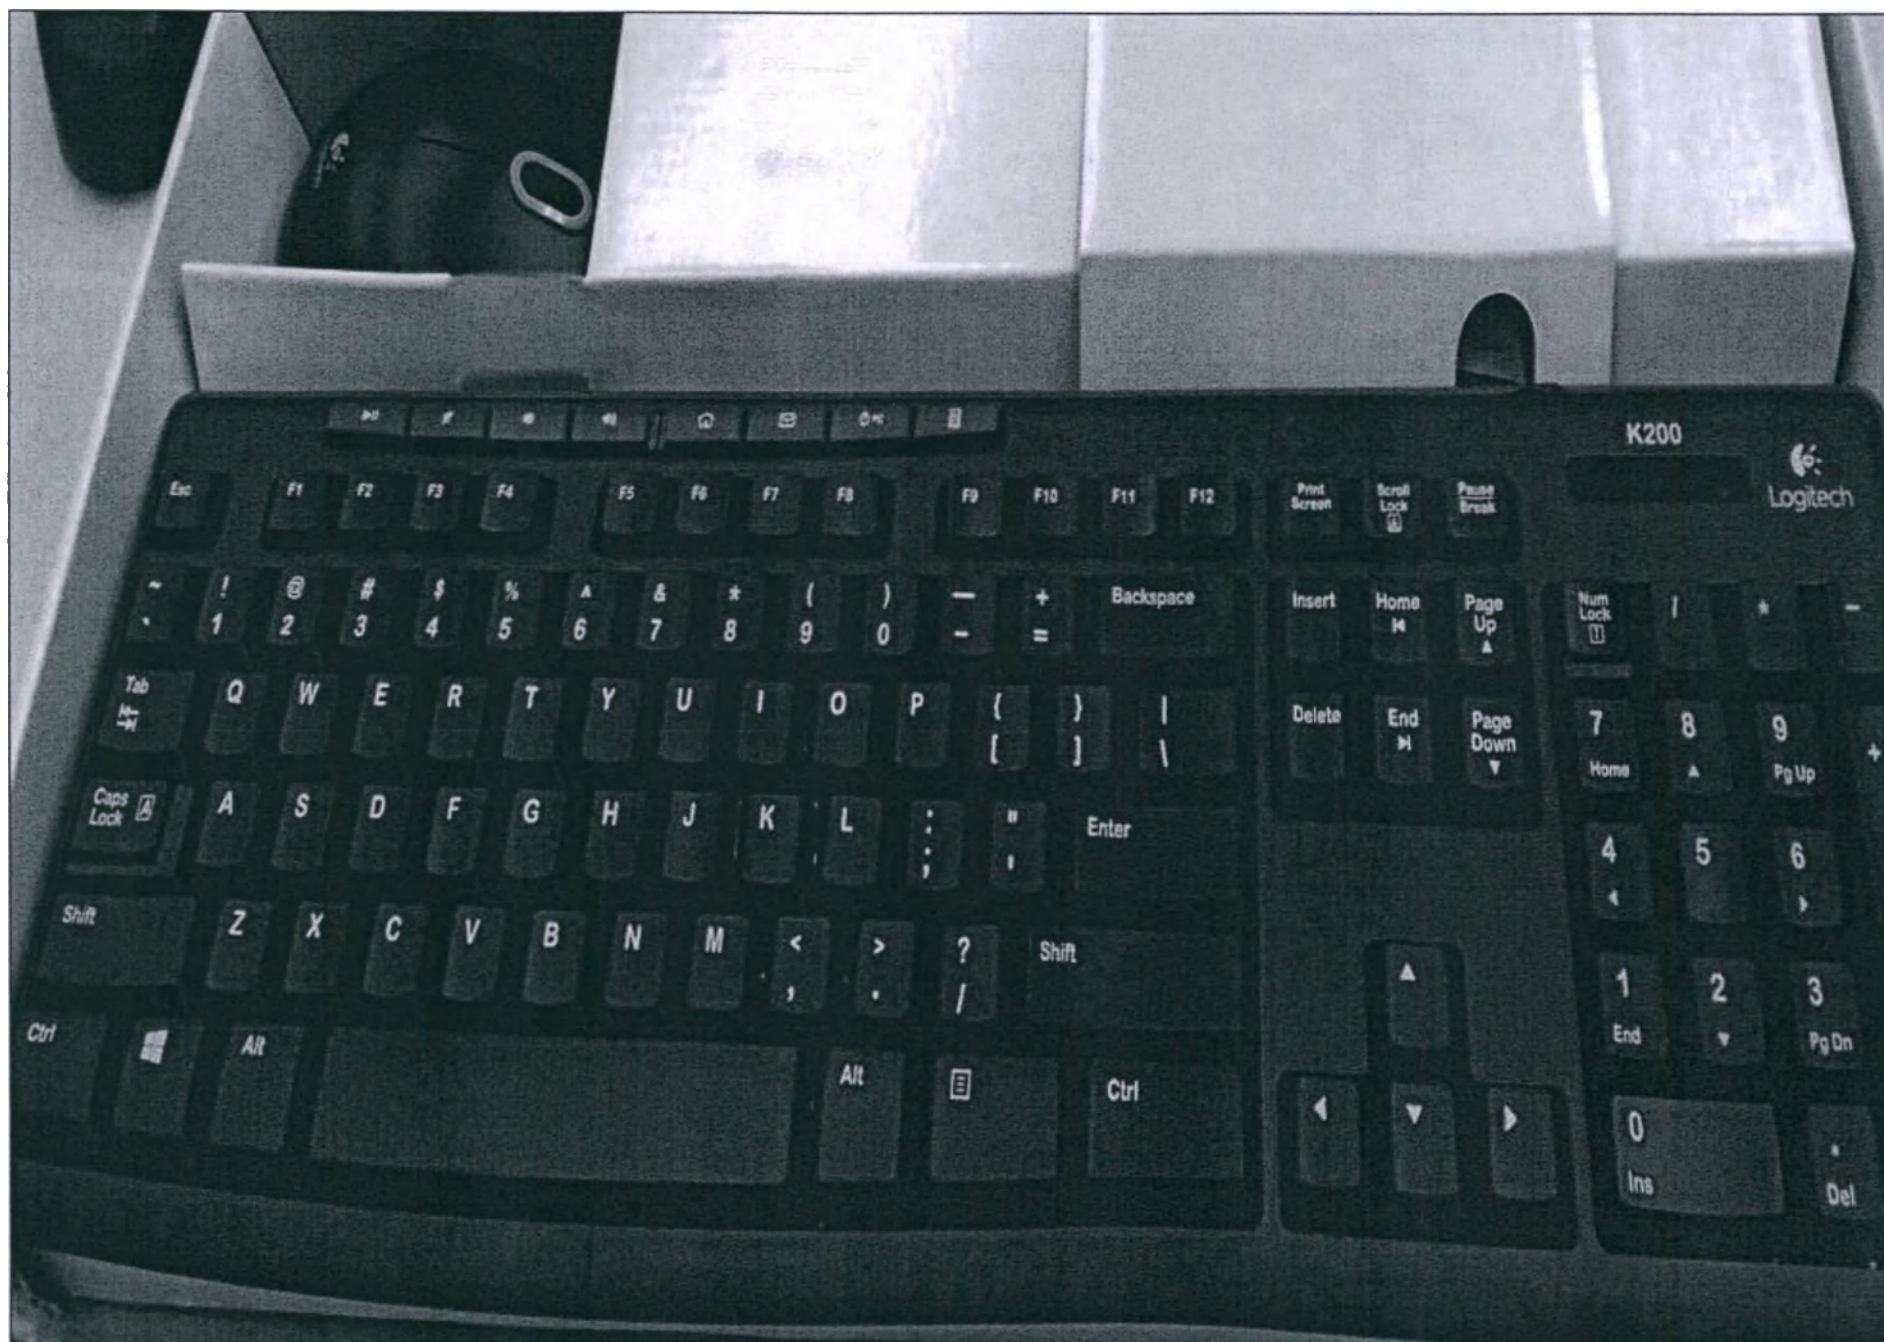

21.1.в. Рабочая станция ClarifEye: - системный блок с программным приложением для системы дополненной реальности ClarifEye версия 1.0 и выше; - цветной монитор с диагональю 24 дюйма; - клавиатура; - мышь.



21.1.2. Рабочая станция ClarifEye: - системный блок с программным приложением для системы дополненной реальности ClarifEye версия 1.0 и выше; - цветной монитор с диагональю 24 дюйма; - клавиатура; - *мышь*.

XXXX XXX XXXXX

ProductDescription


SN XXXXXXXXX

© Koninklijke Philips N.V.


All rights reserved.



21.2.a. Приложение программное ClarifEye на электронном носителе.

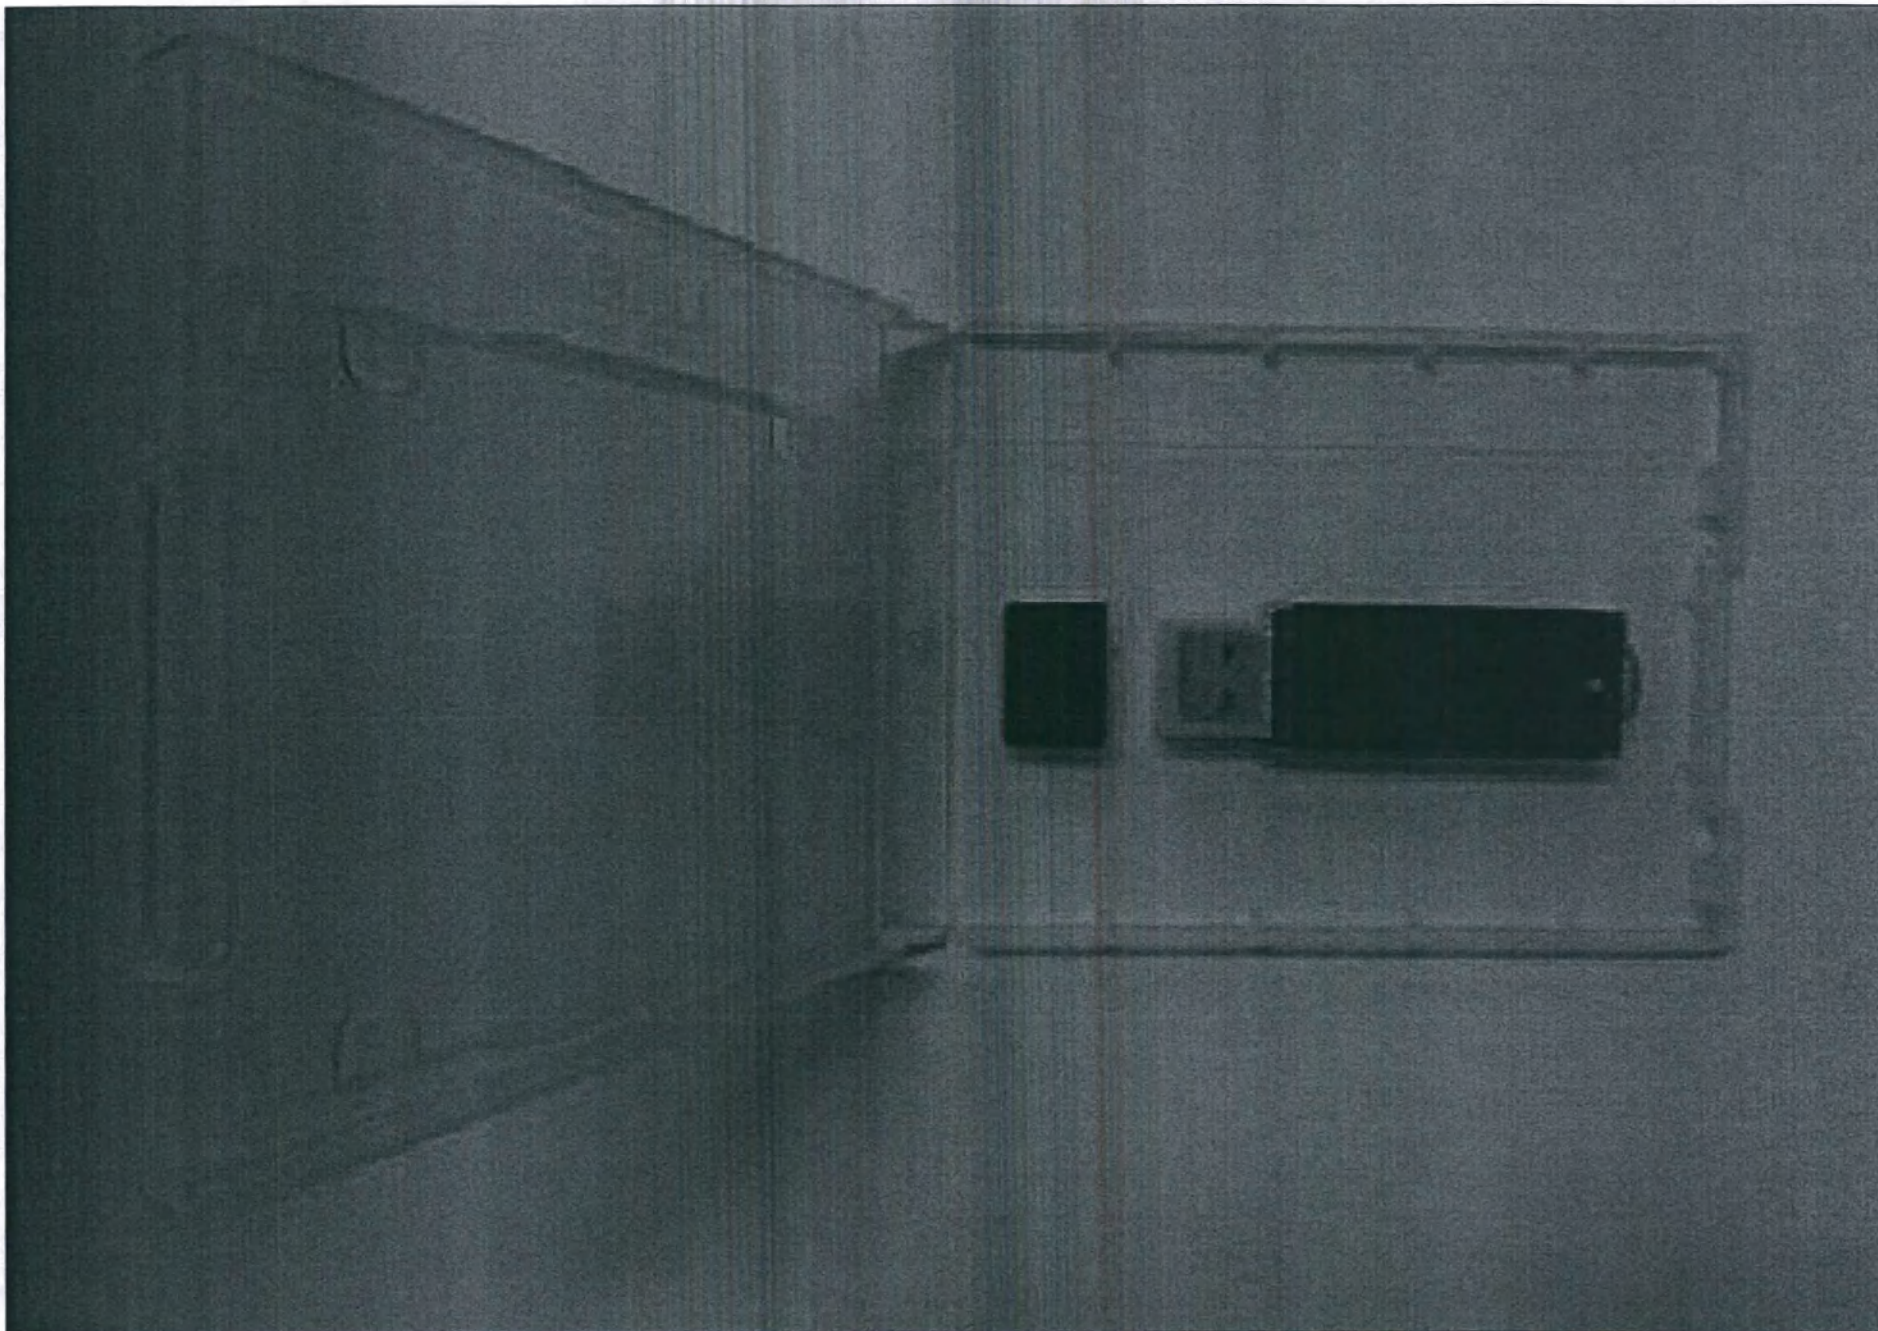


21.2. 6. Приложение программное ClarifEye на электронном носителе.

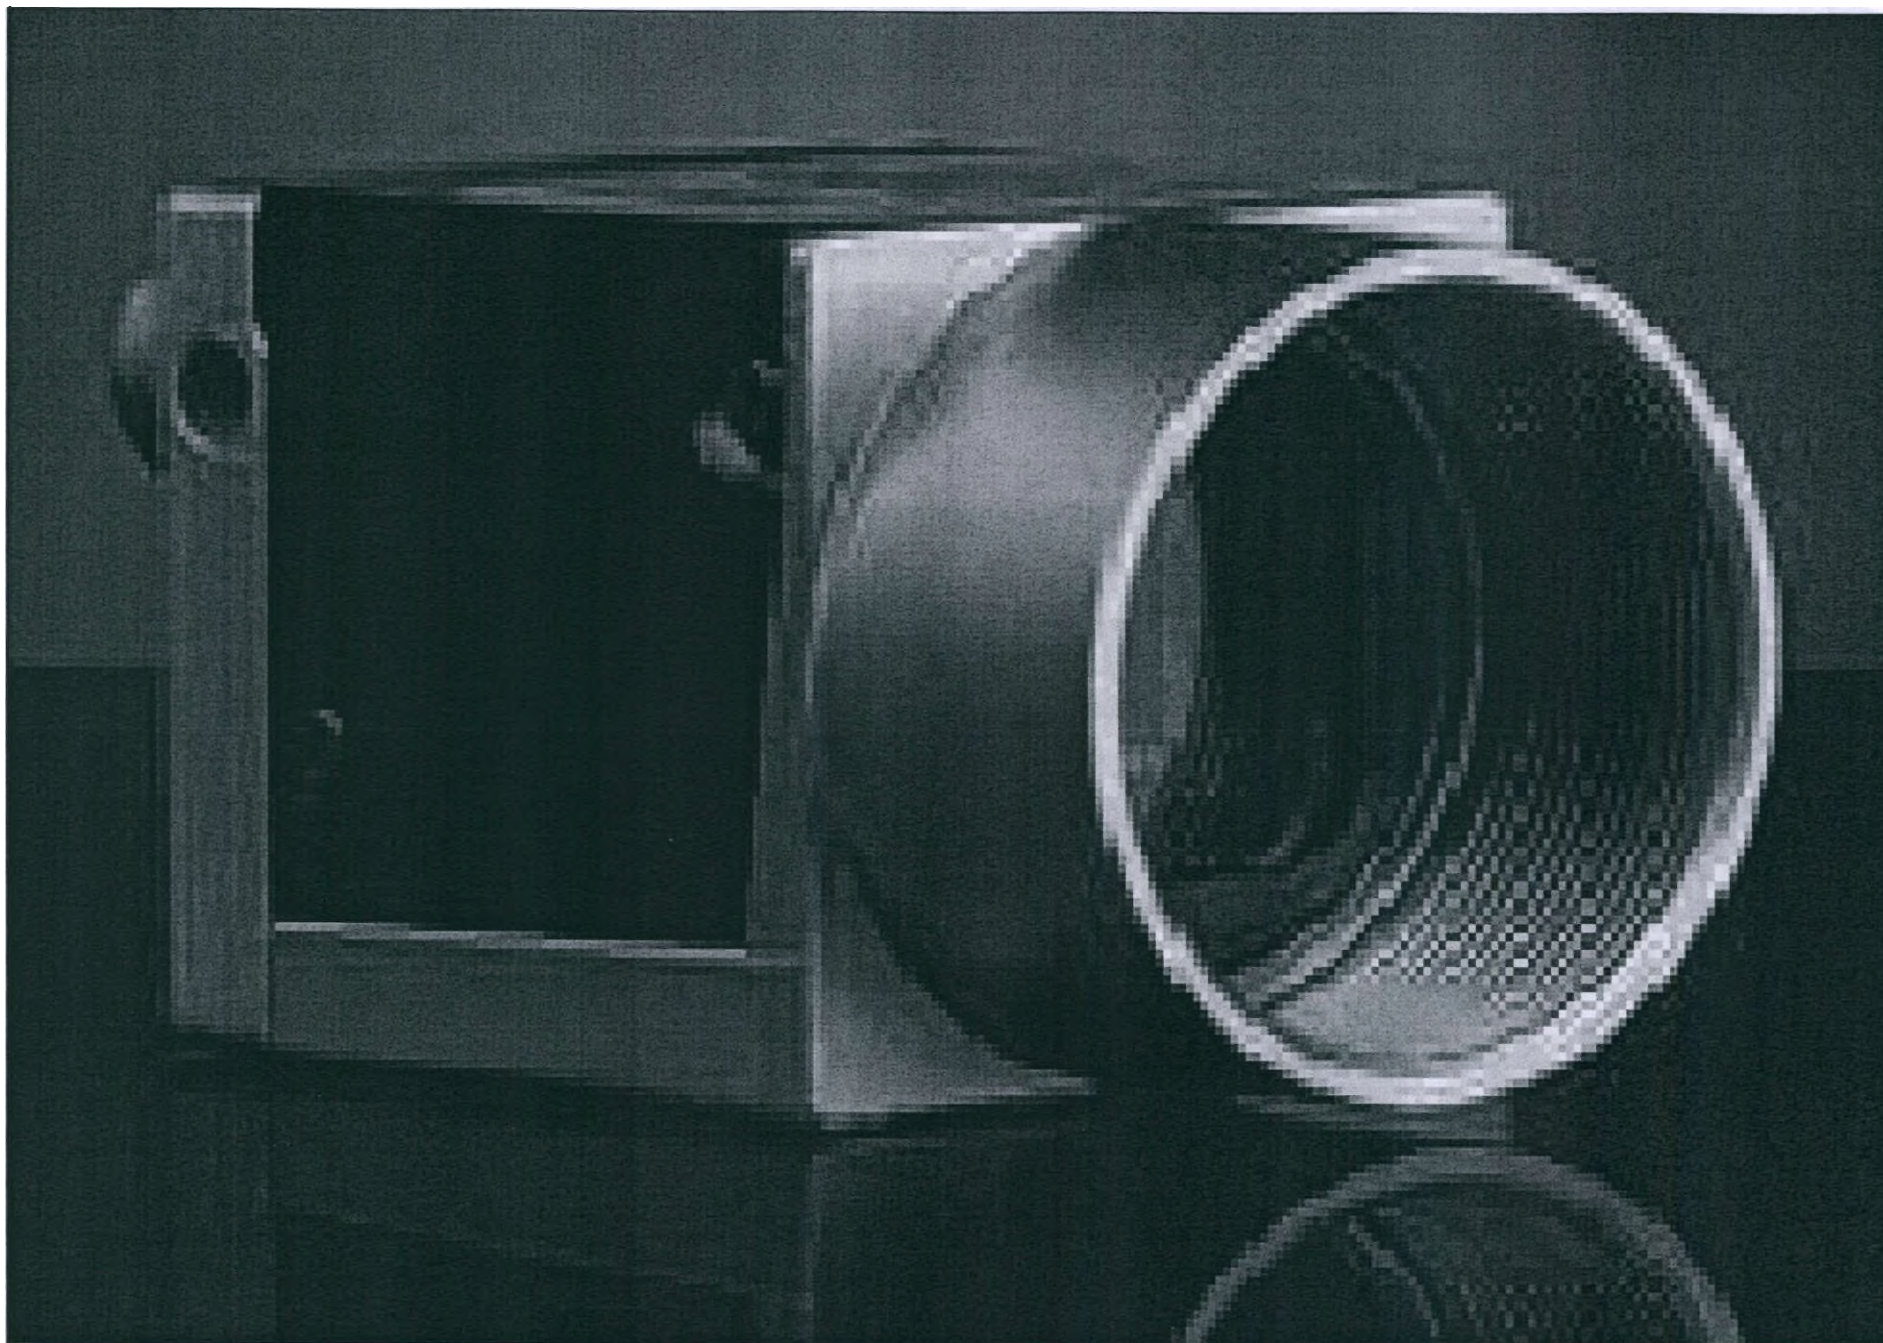


21.3.а. Камеры для детектора С20, не более 4 шт.




21.3.б. Камеры для детектора C20, не более 4 шт.

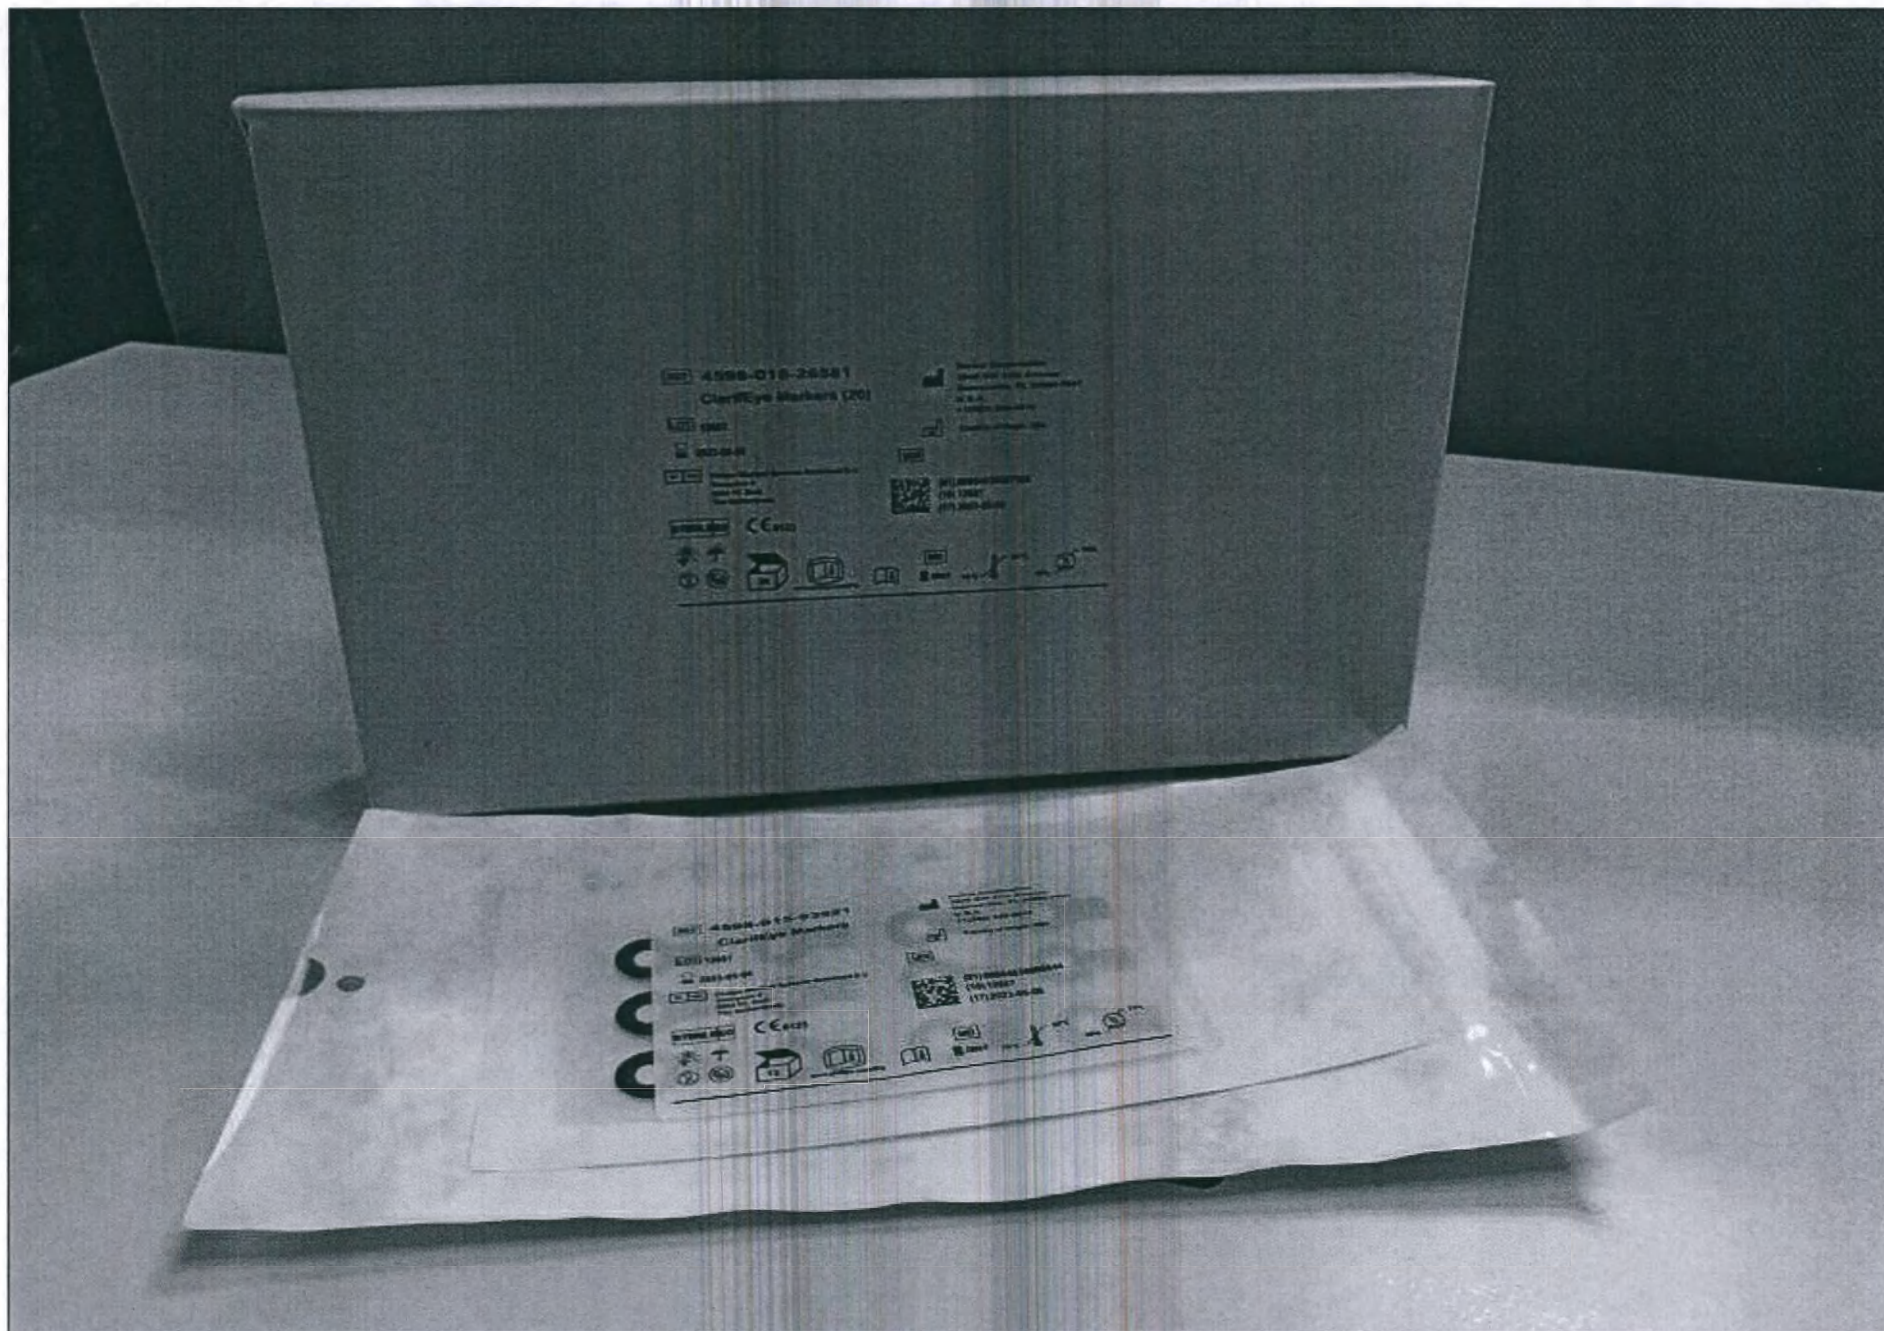


21.4.6. Маркеры кожные оптические стерильные одноразовые ClarifEye Marker, 240 шт./уп. (не более 20 уп.)

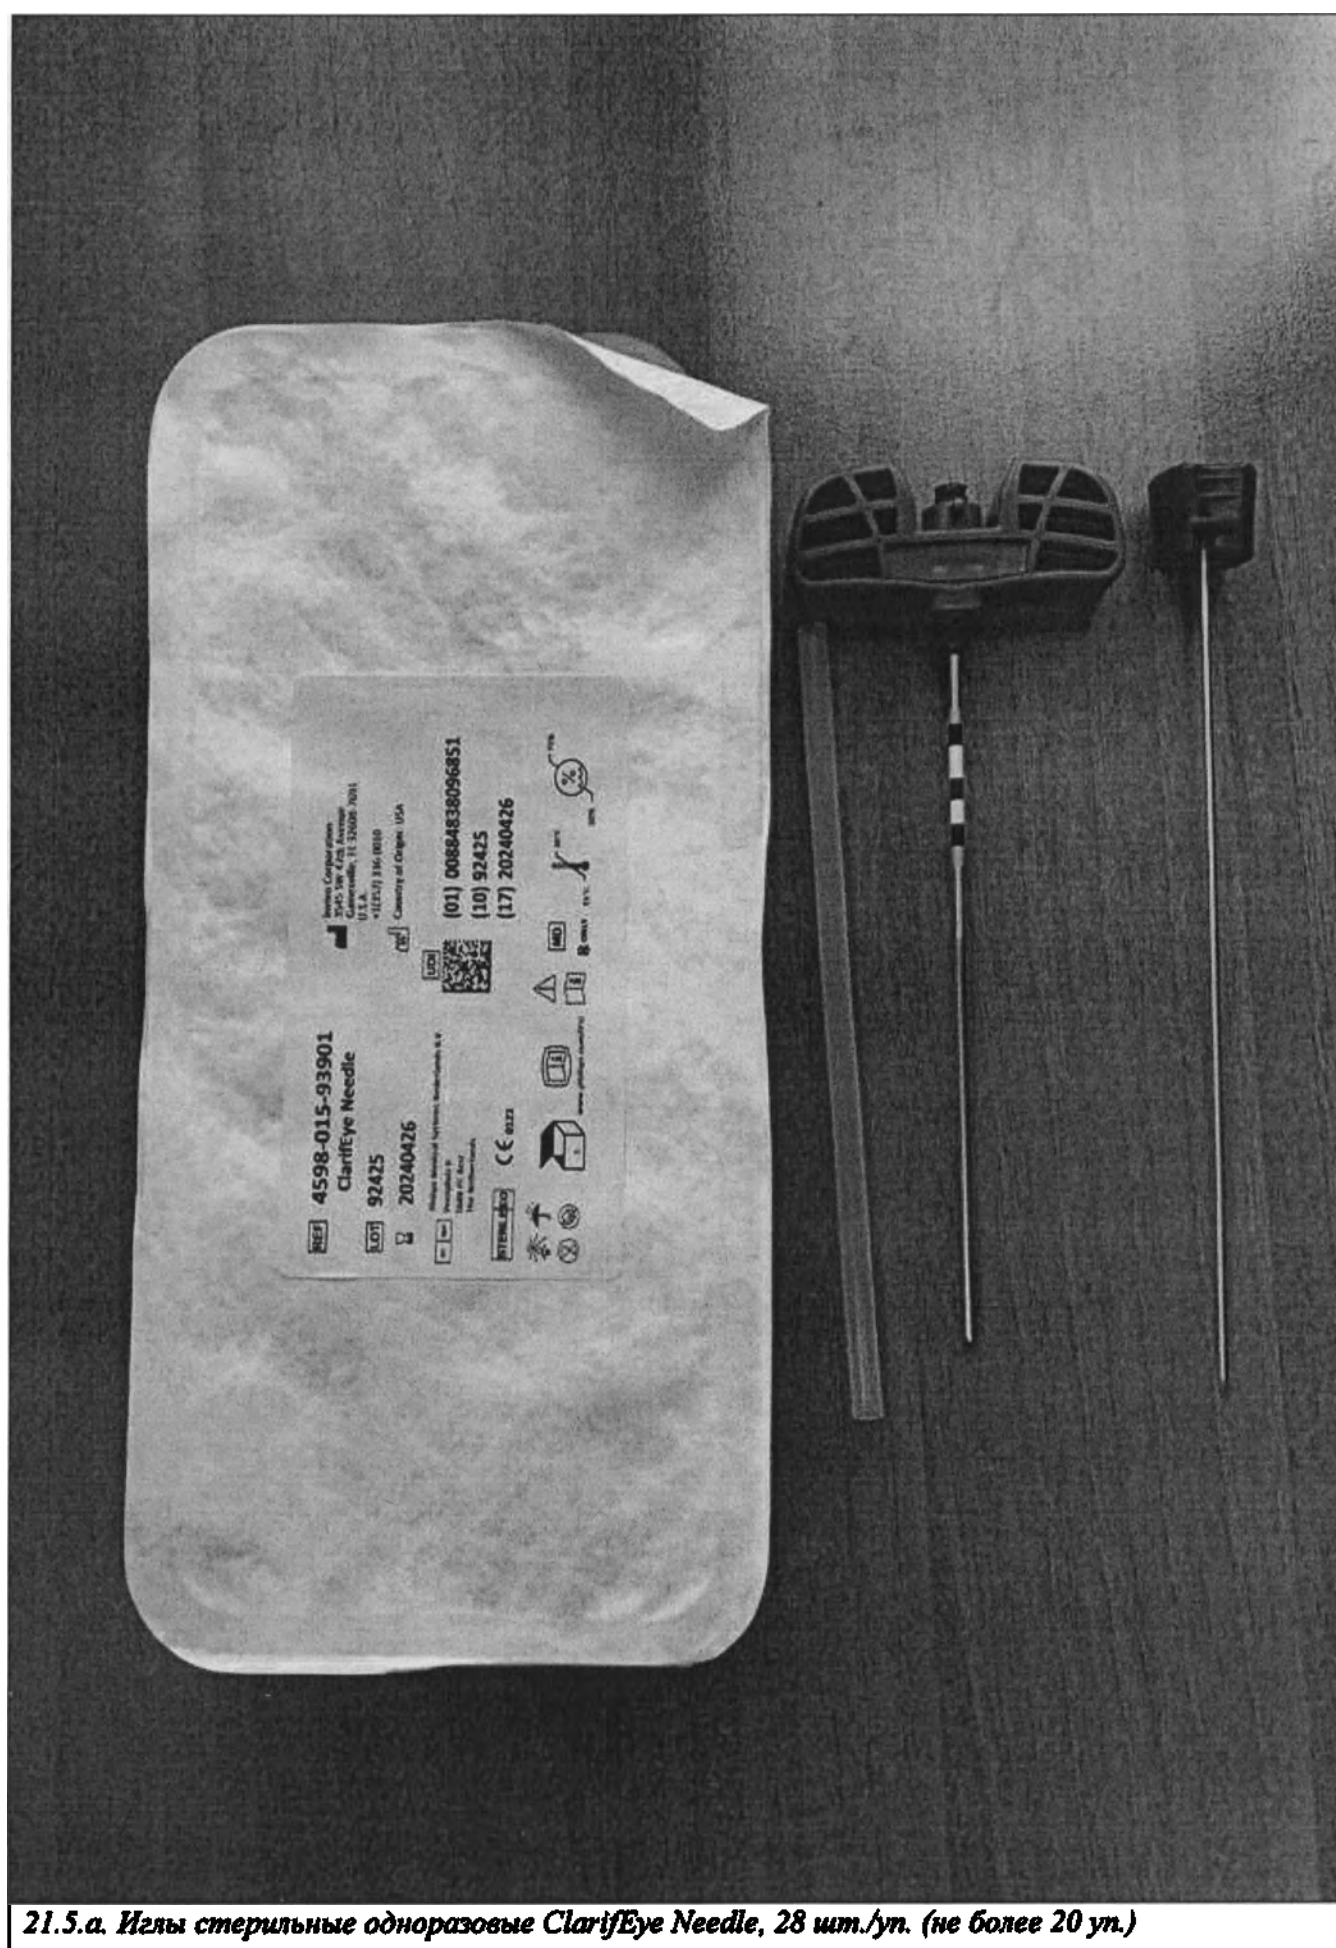

21.5.a. Иглы стерильные одноразовые ClarifEye Needle, 28 шт./уп. (не более 20 уп.)

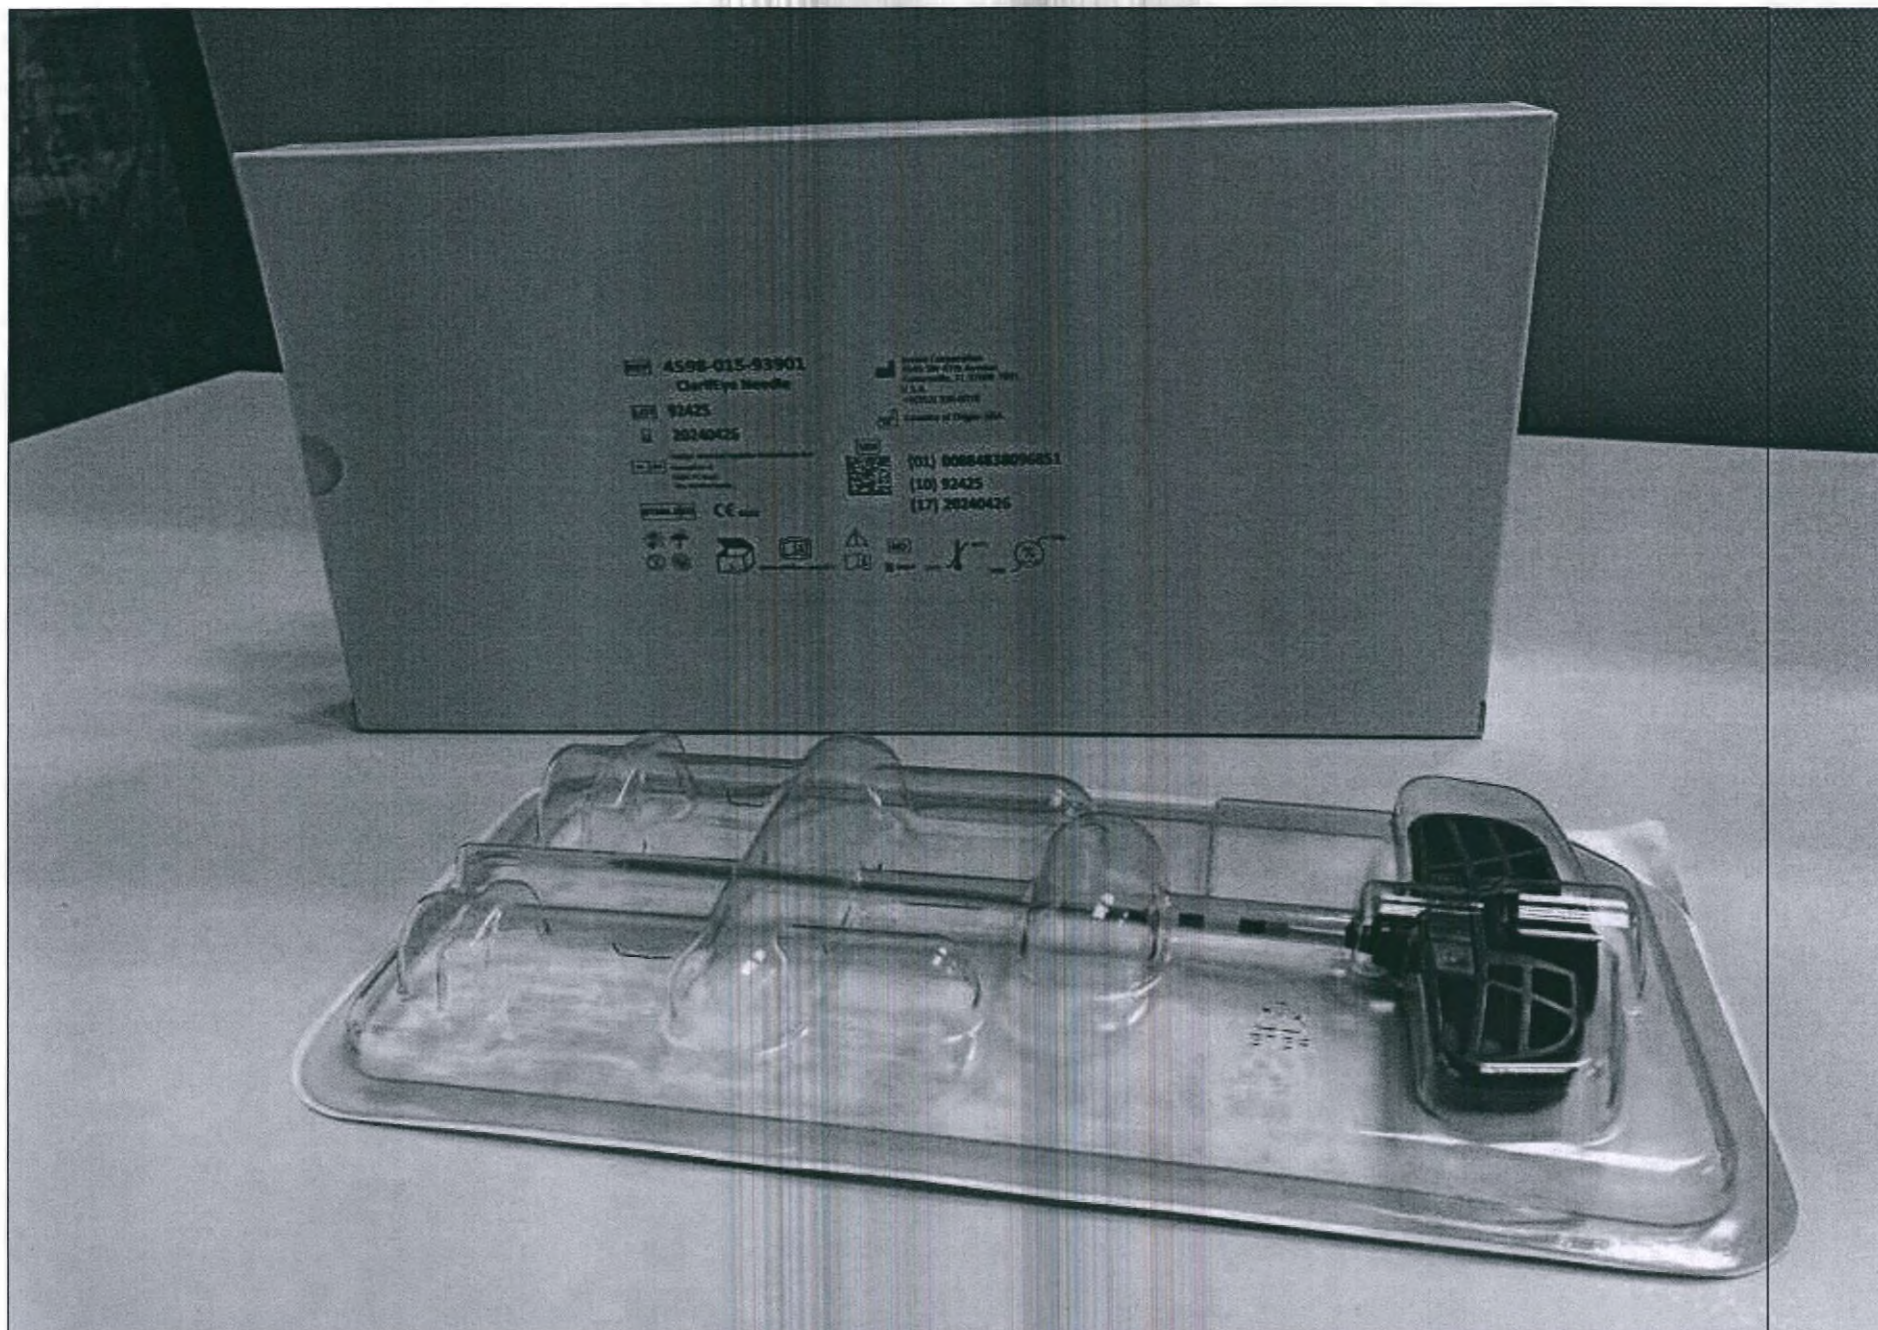

21.5.6. Иглы стерильные одноразовые ClarifEye Needle. Транспортная и стерильная упаковка, инструкция.

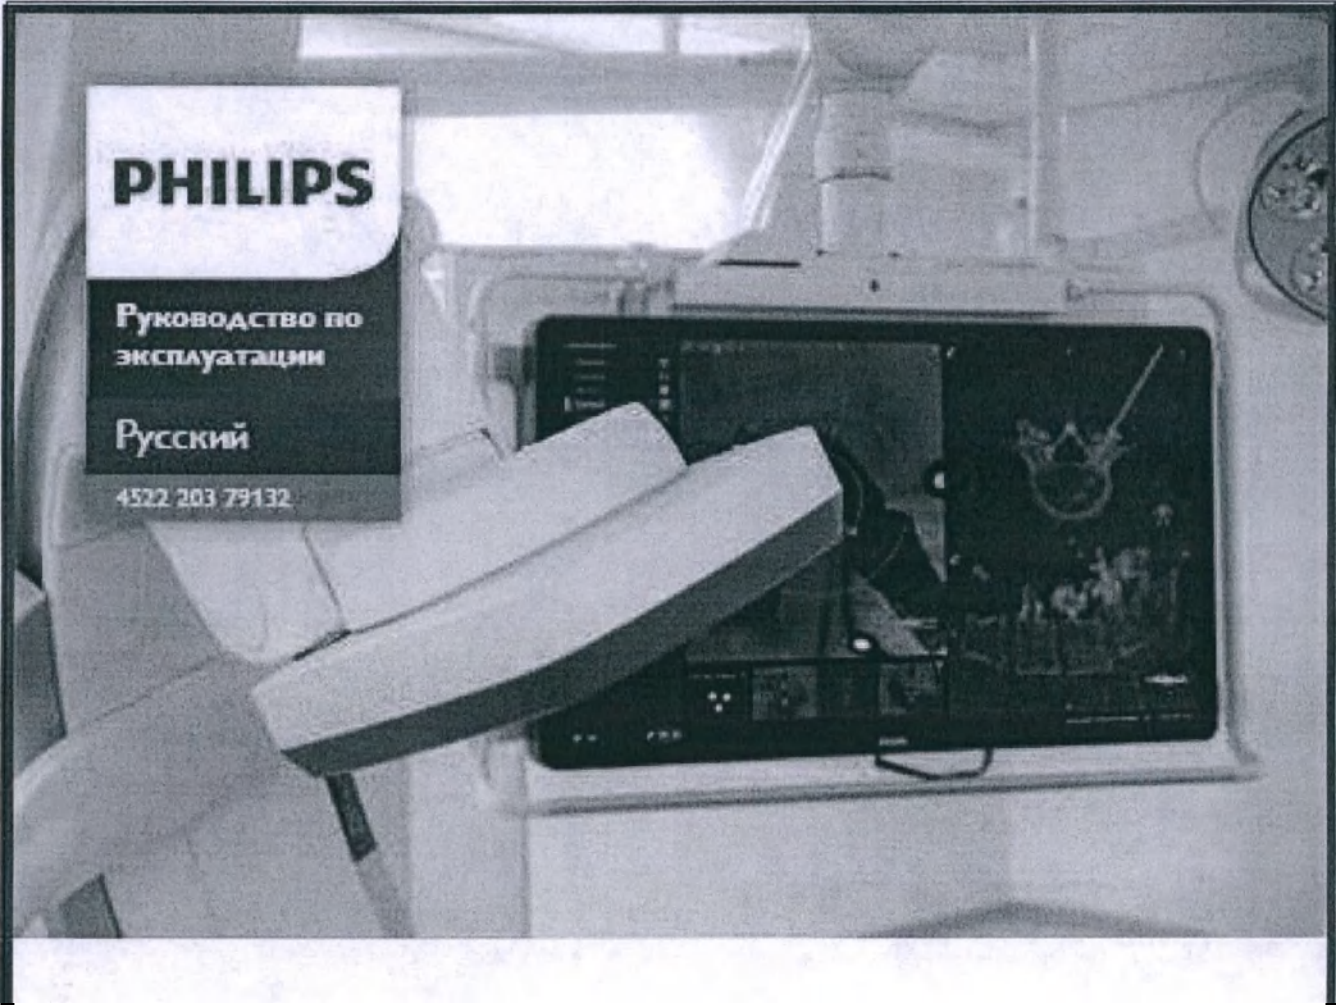

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации


Русский

4522 203 79132


Philips ClarifEye

Версия 1.0


Система ангиографическая Azurion 7 B12:

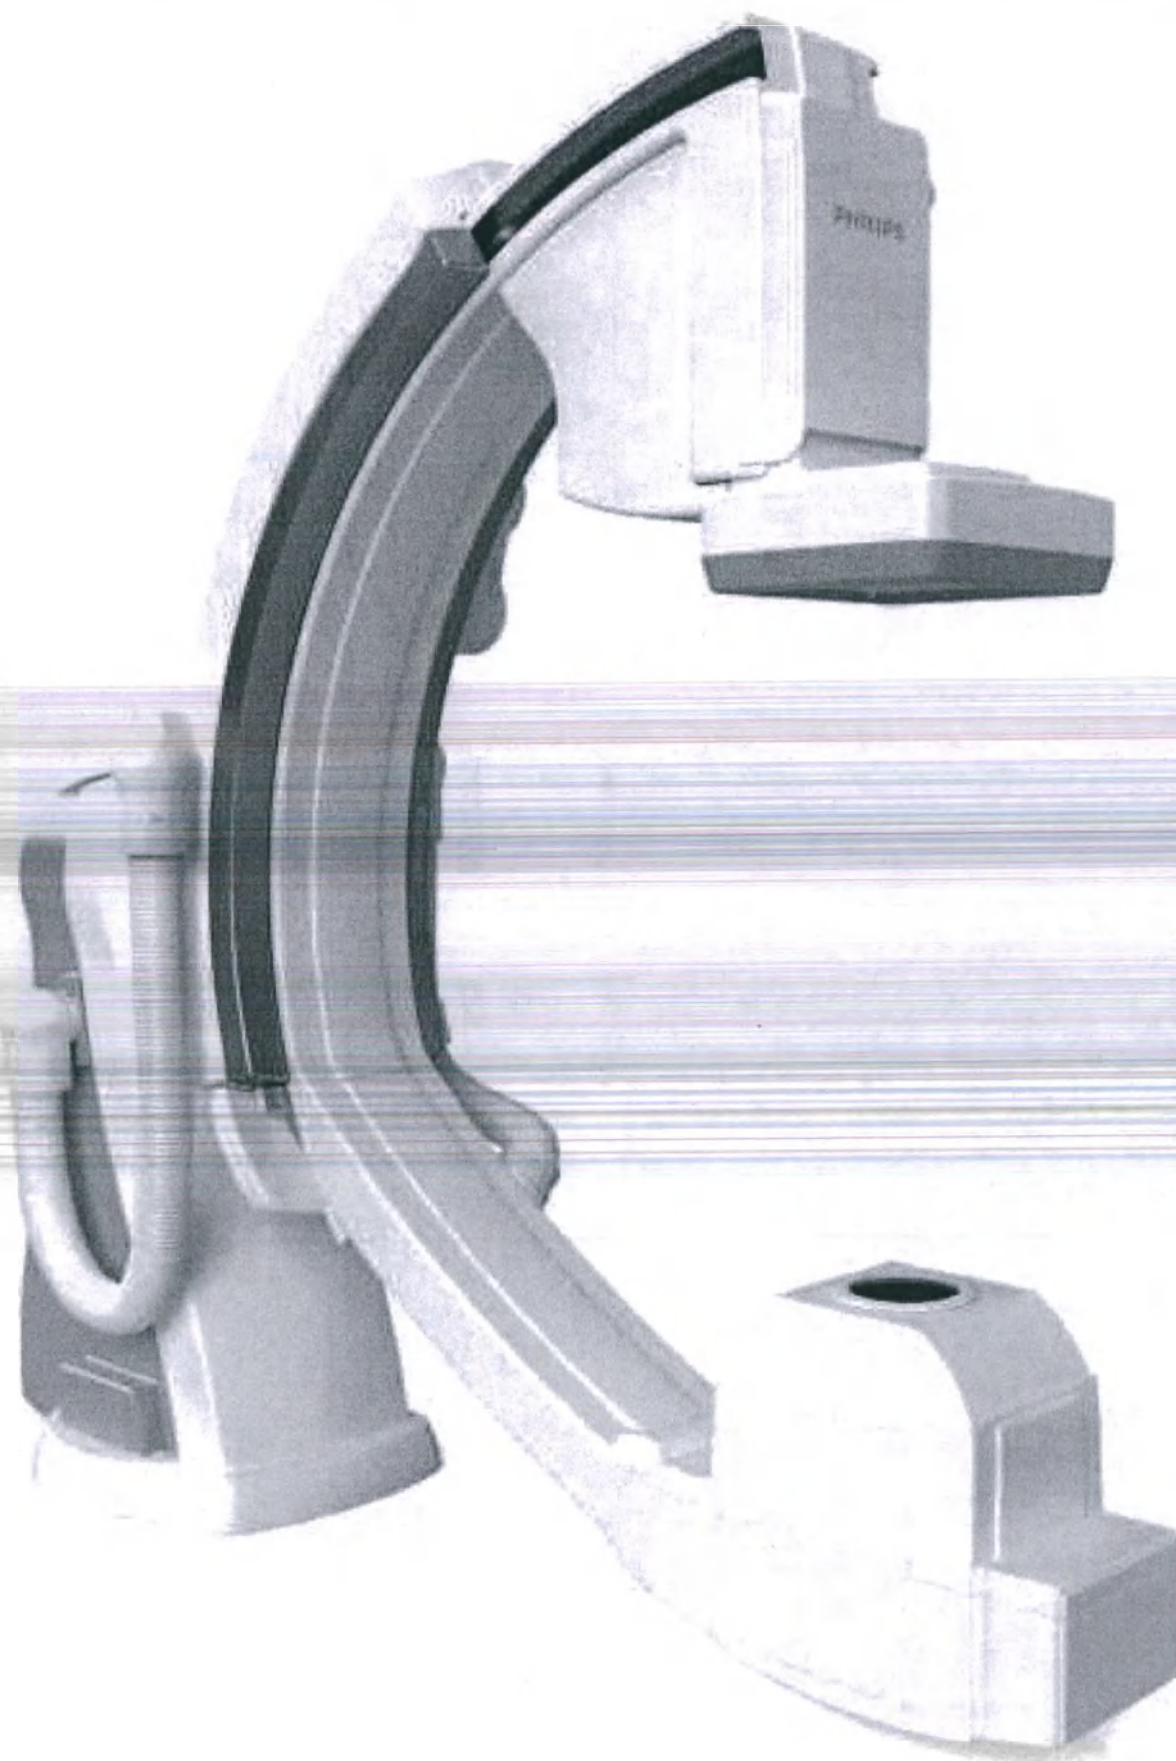


1. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

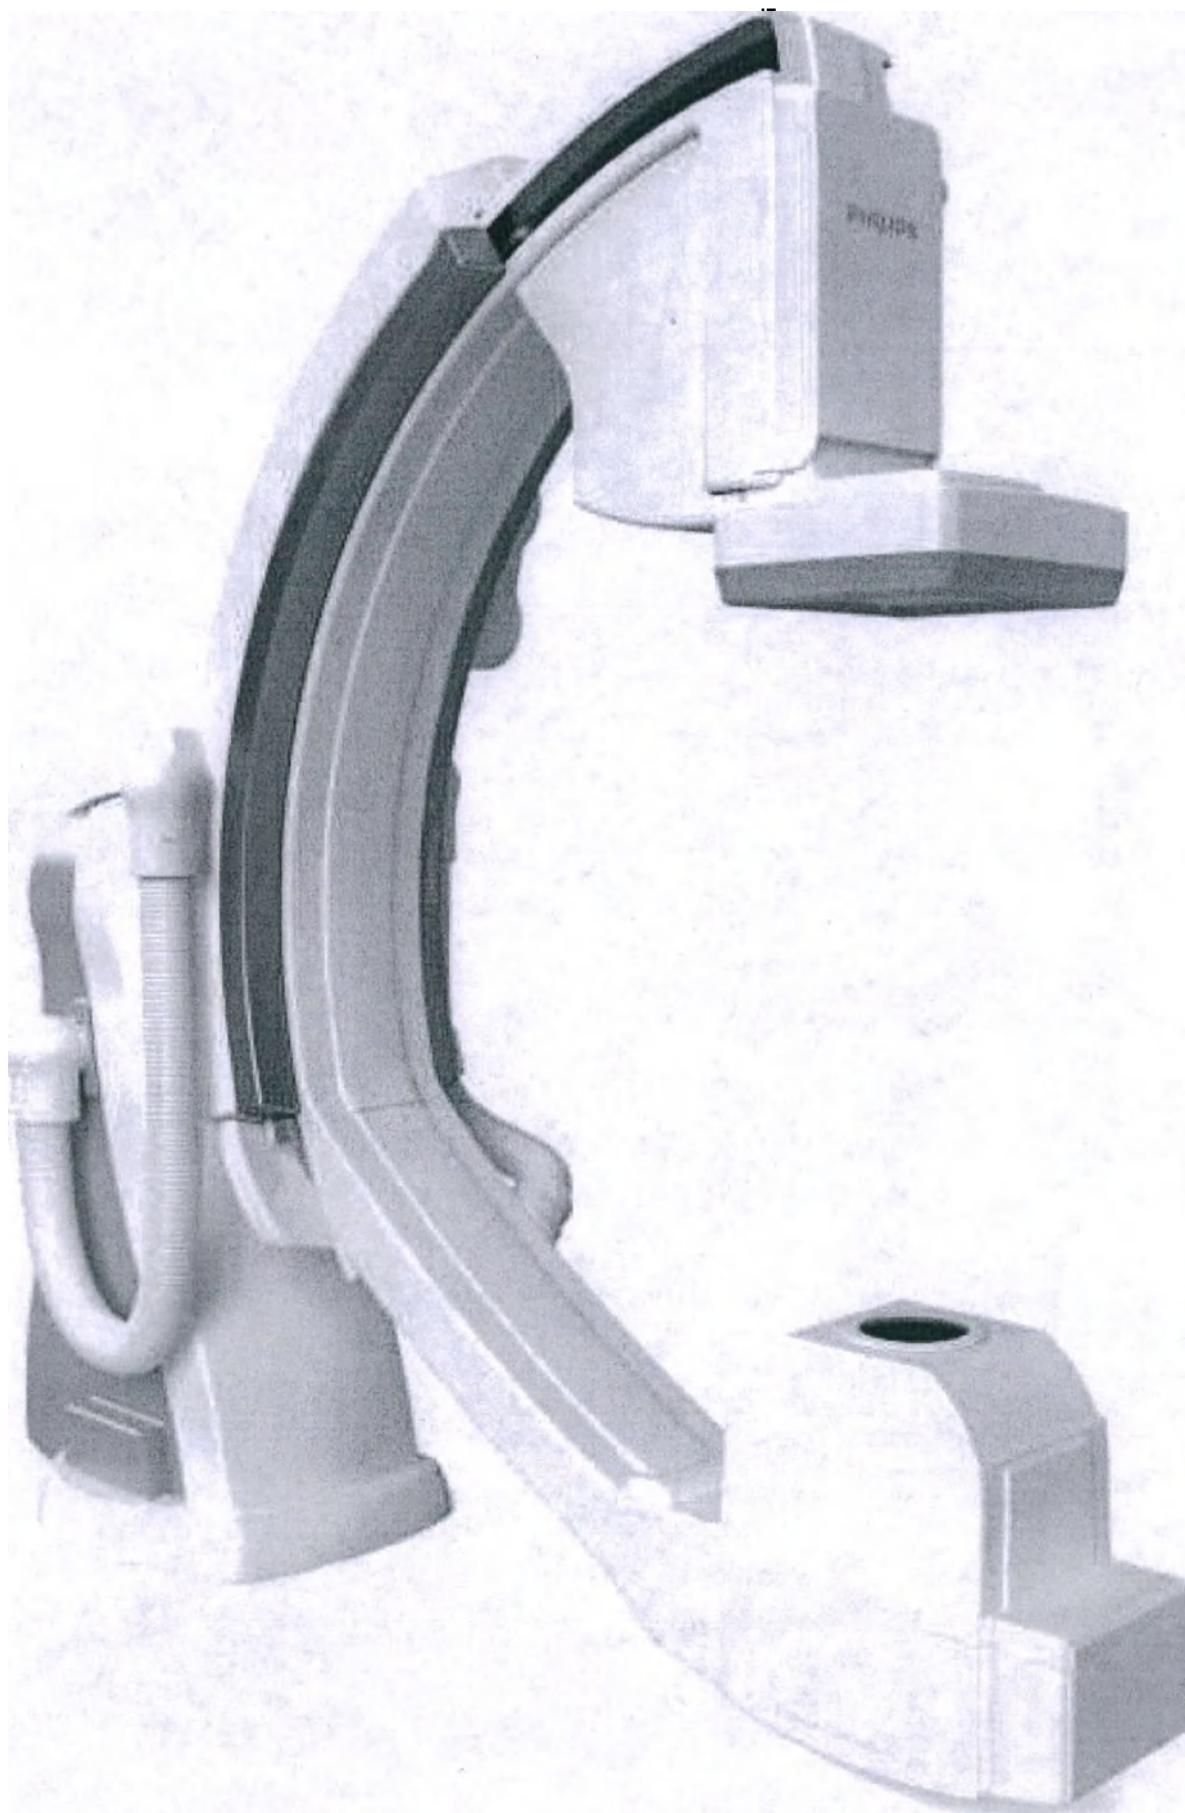


1.а. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

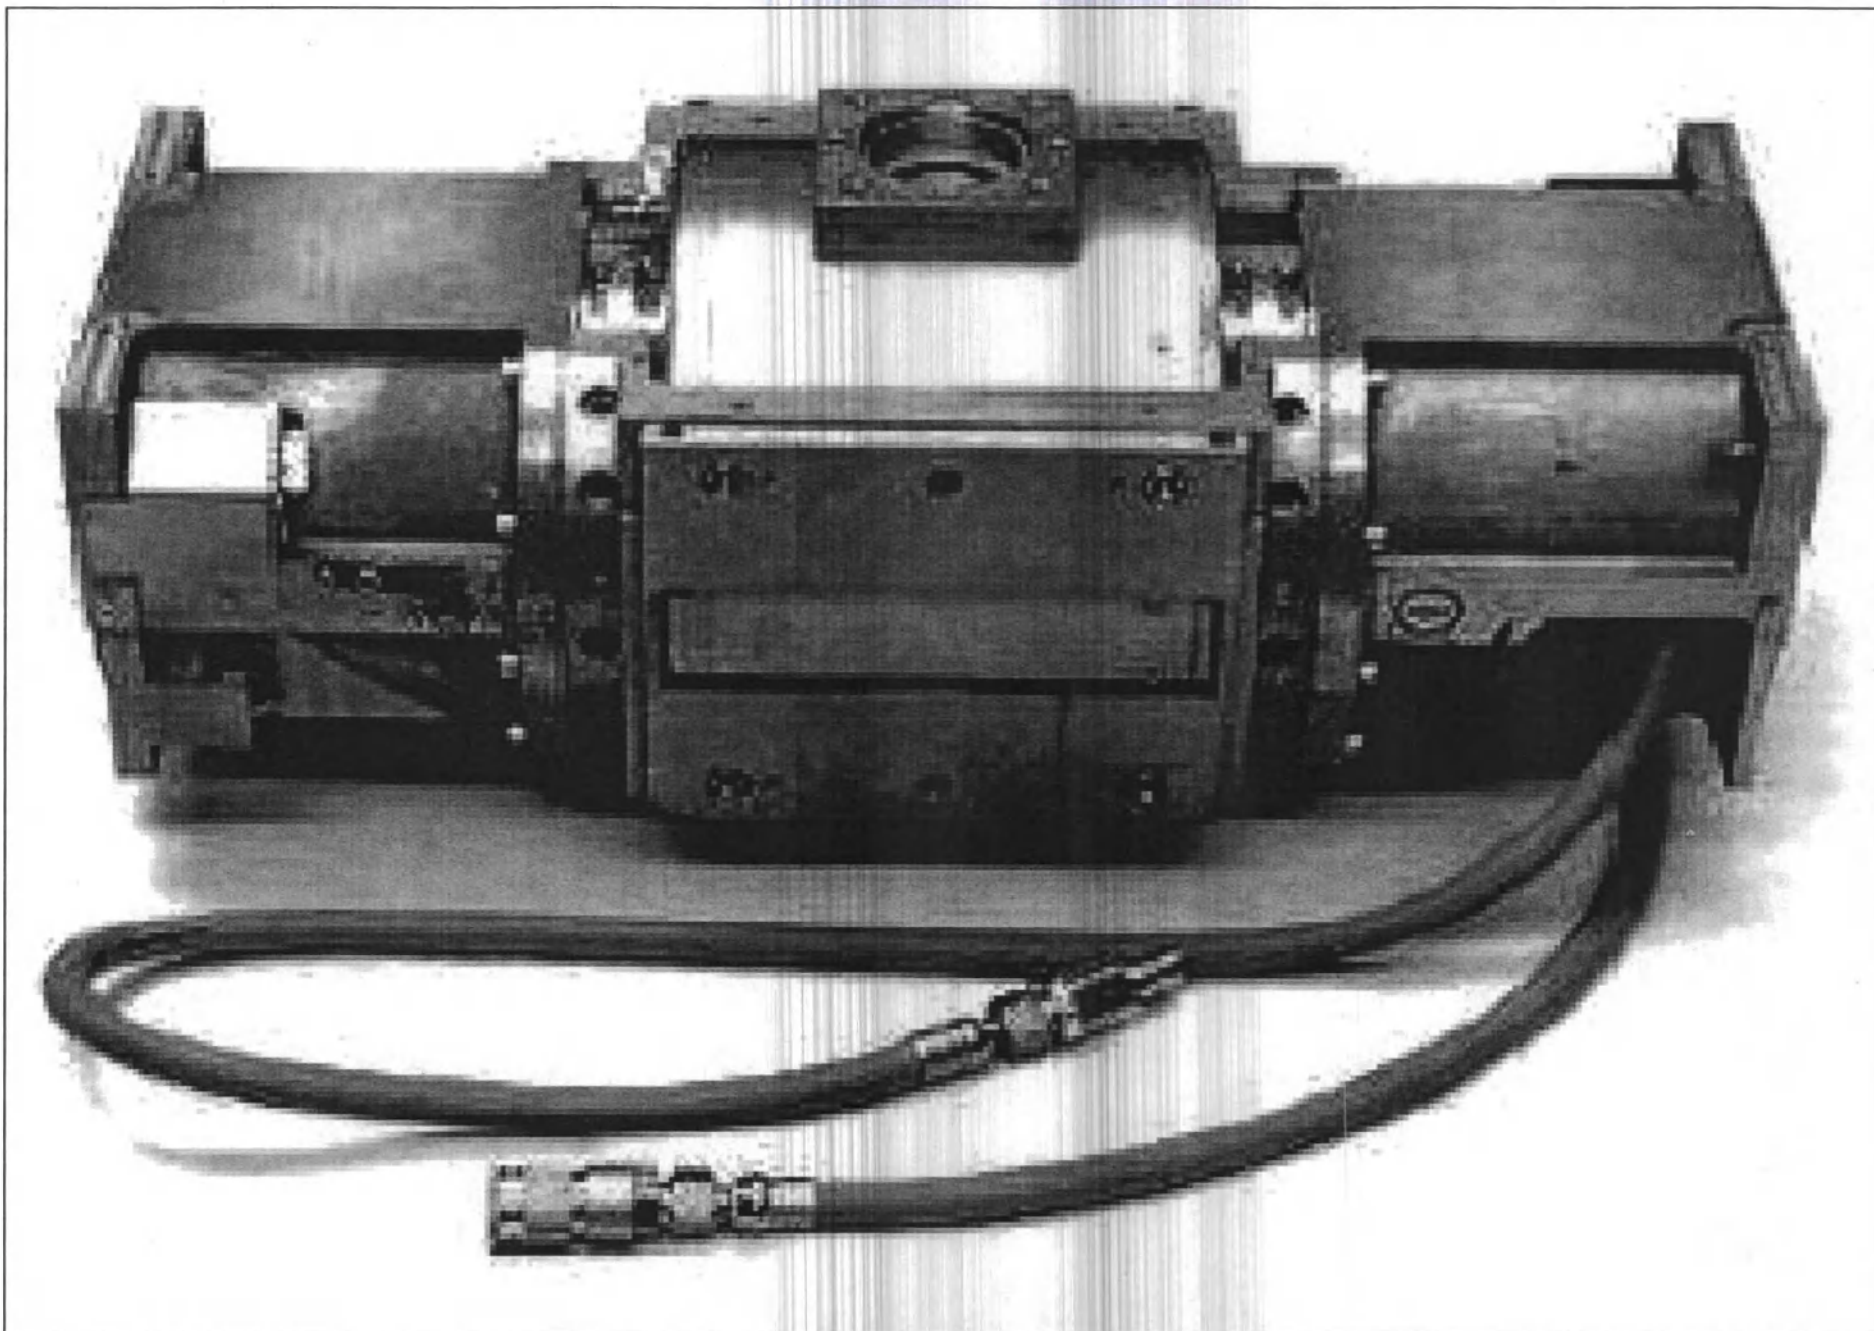


1.6. Модуль С-дуги неполный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

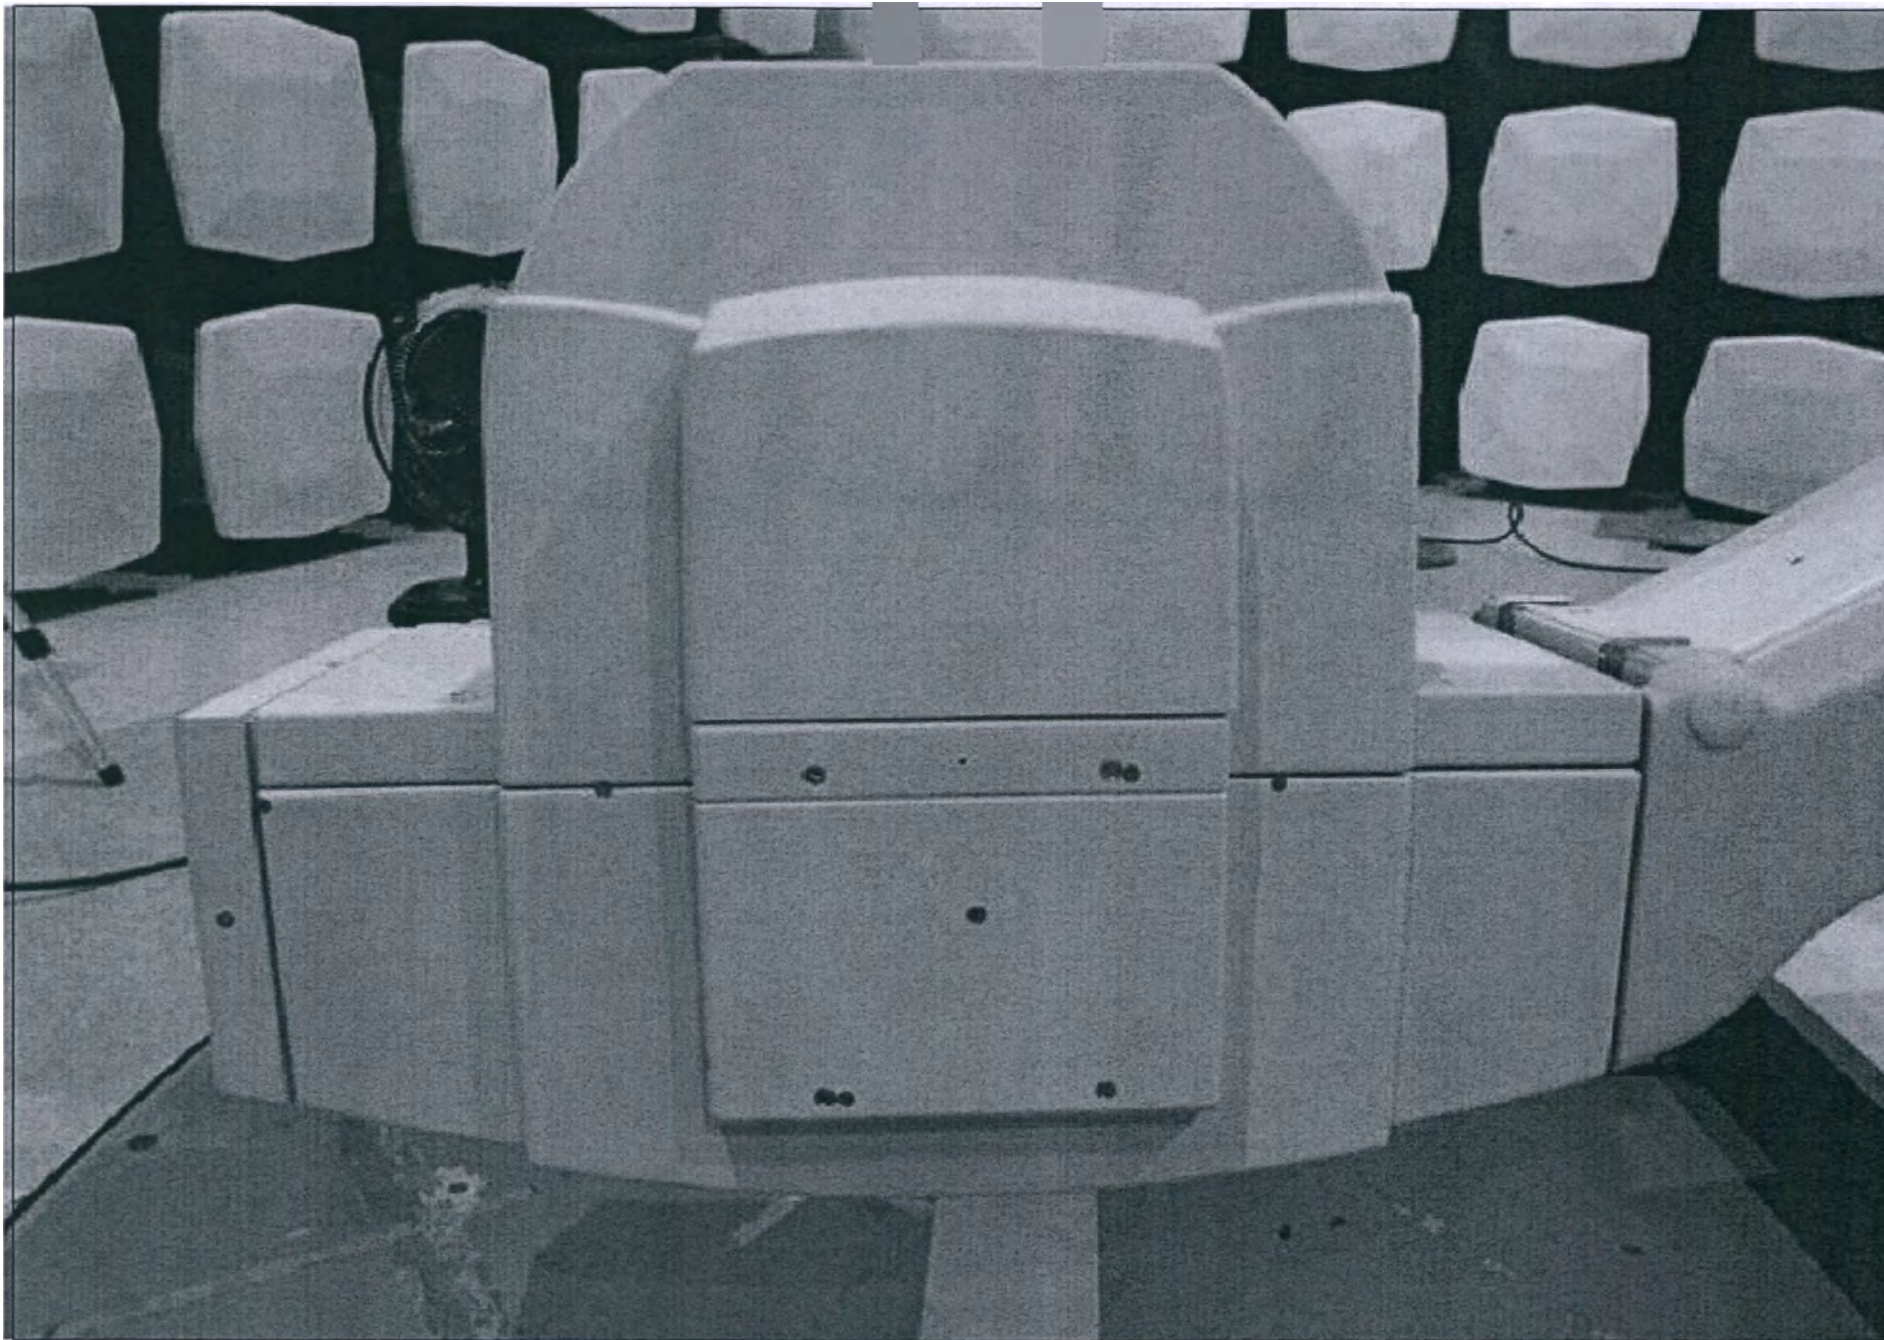


1.в. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

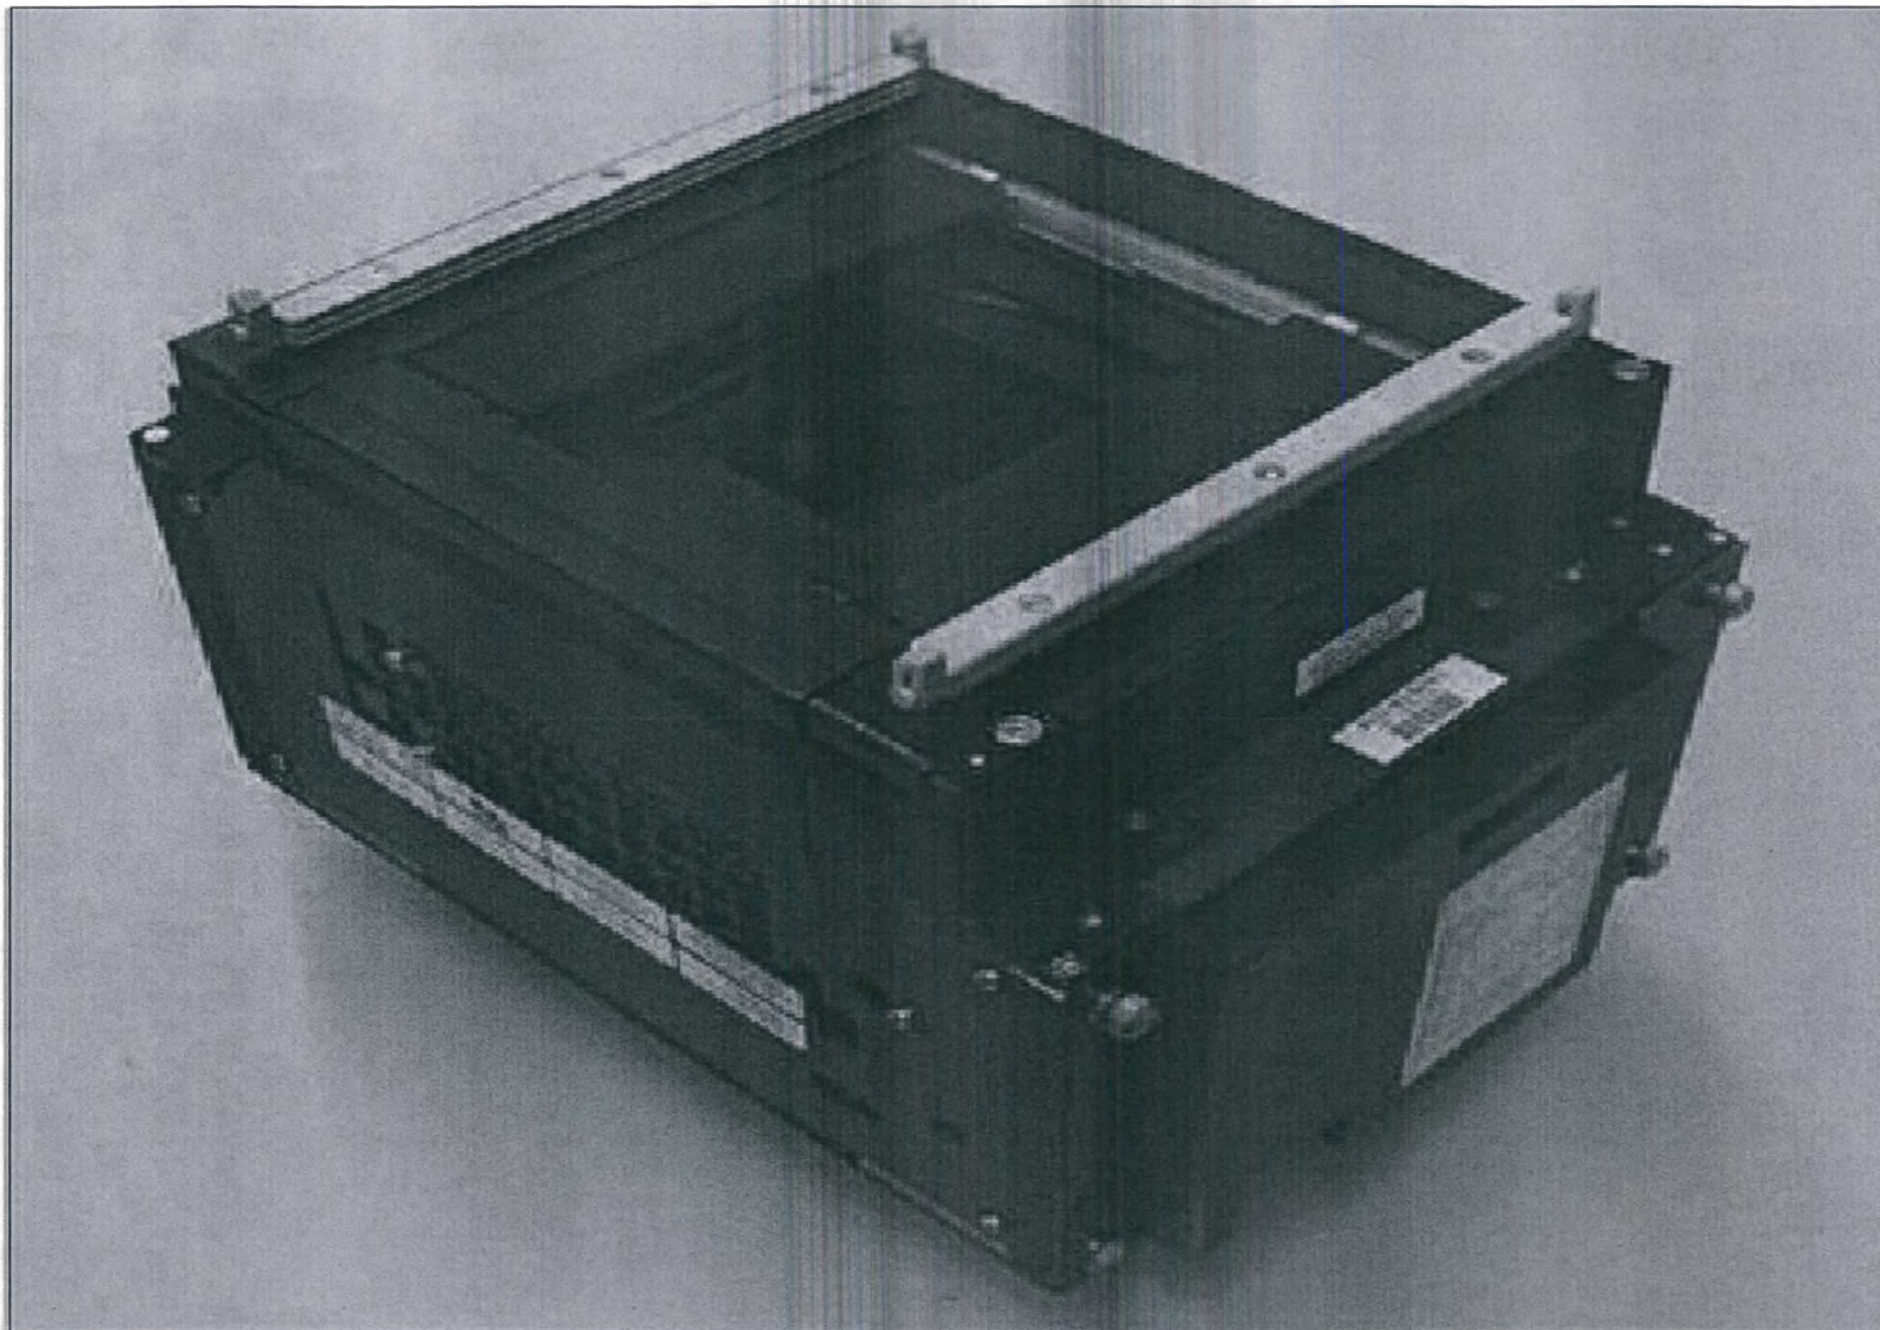


*1.2. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; **коллиматор**; детектор F12.*

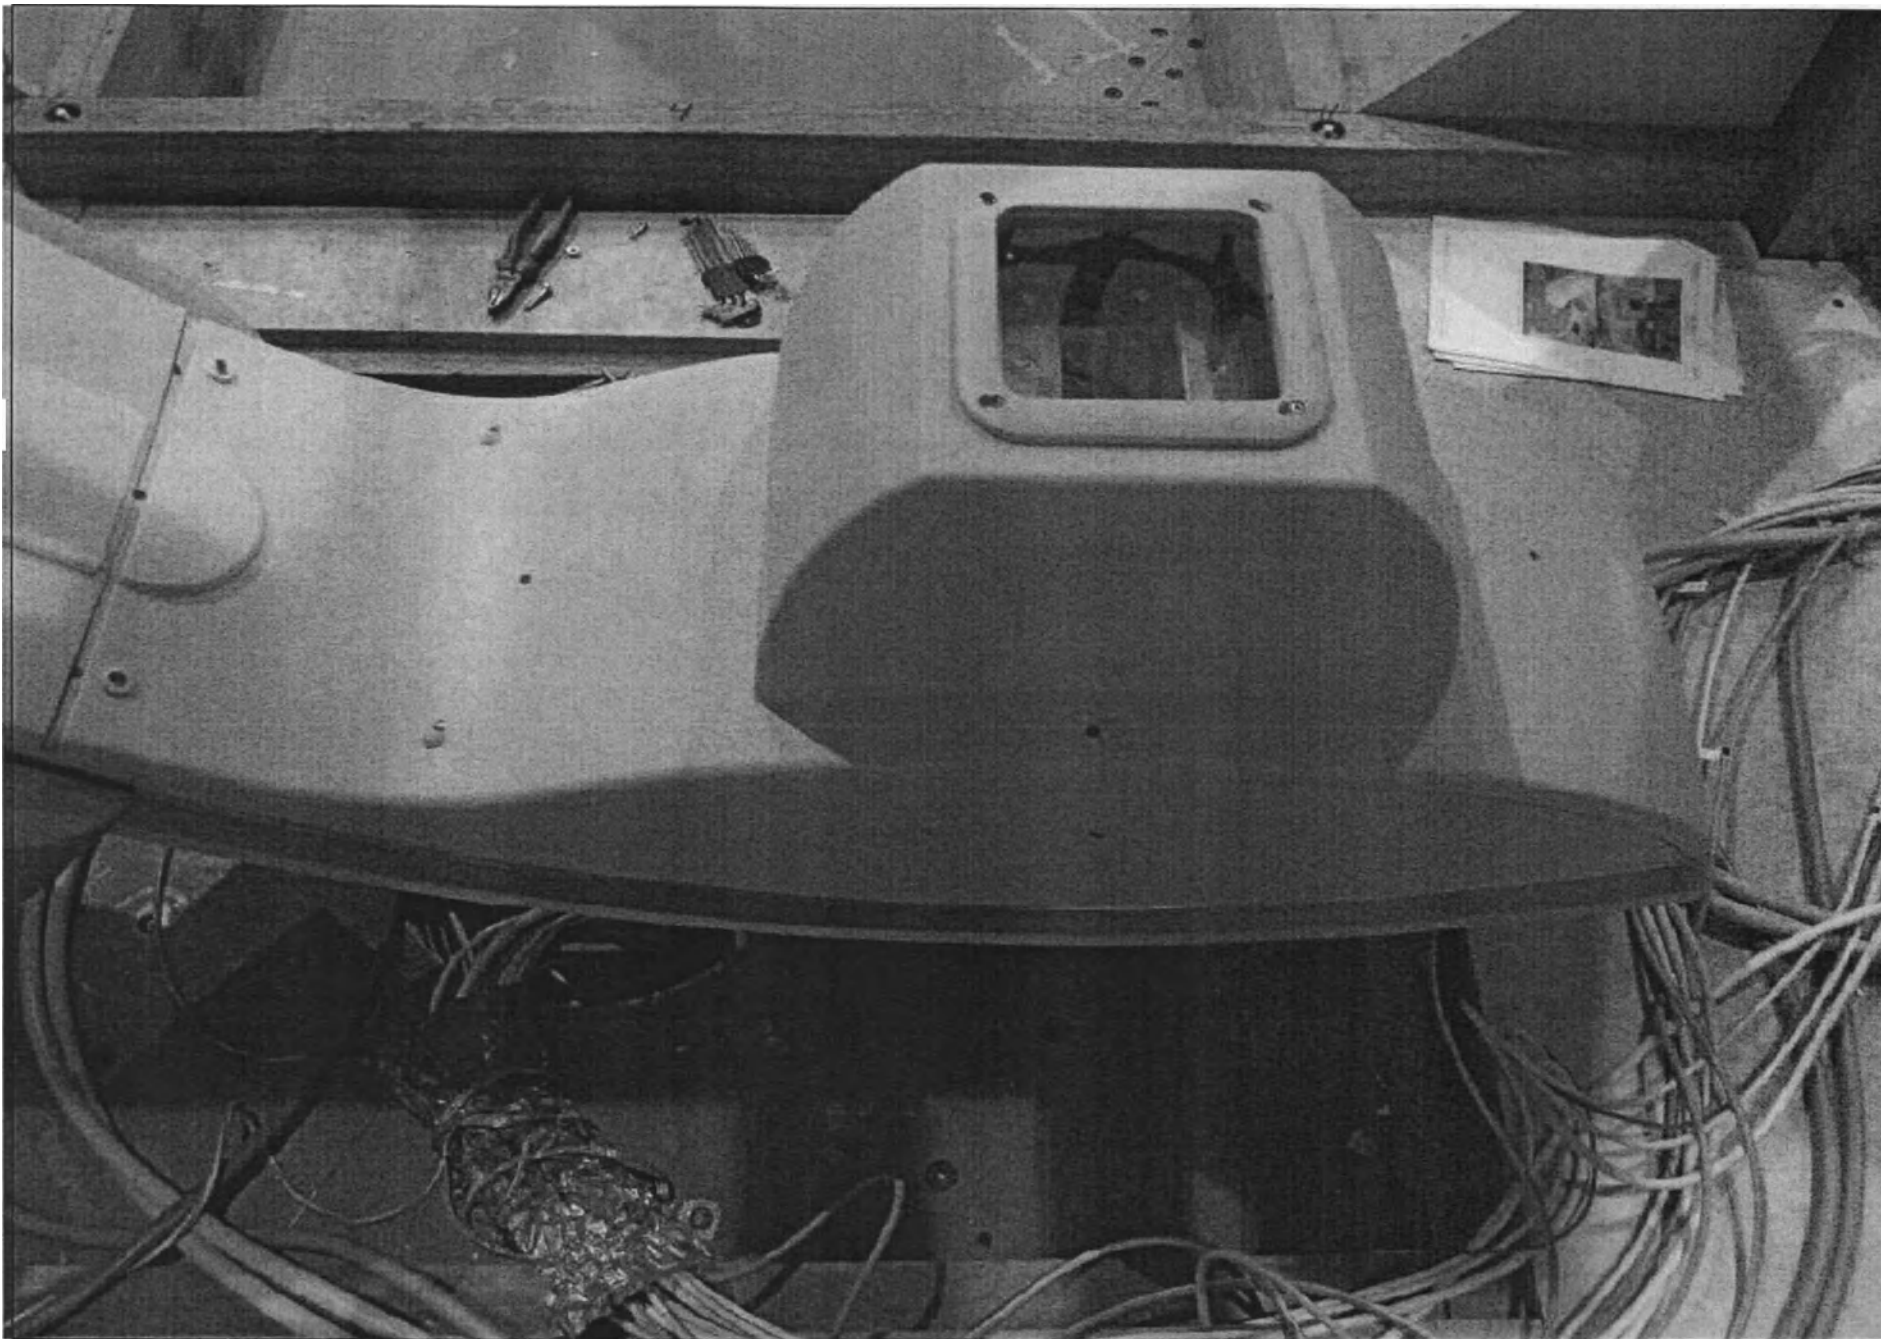


1.д. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

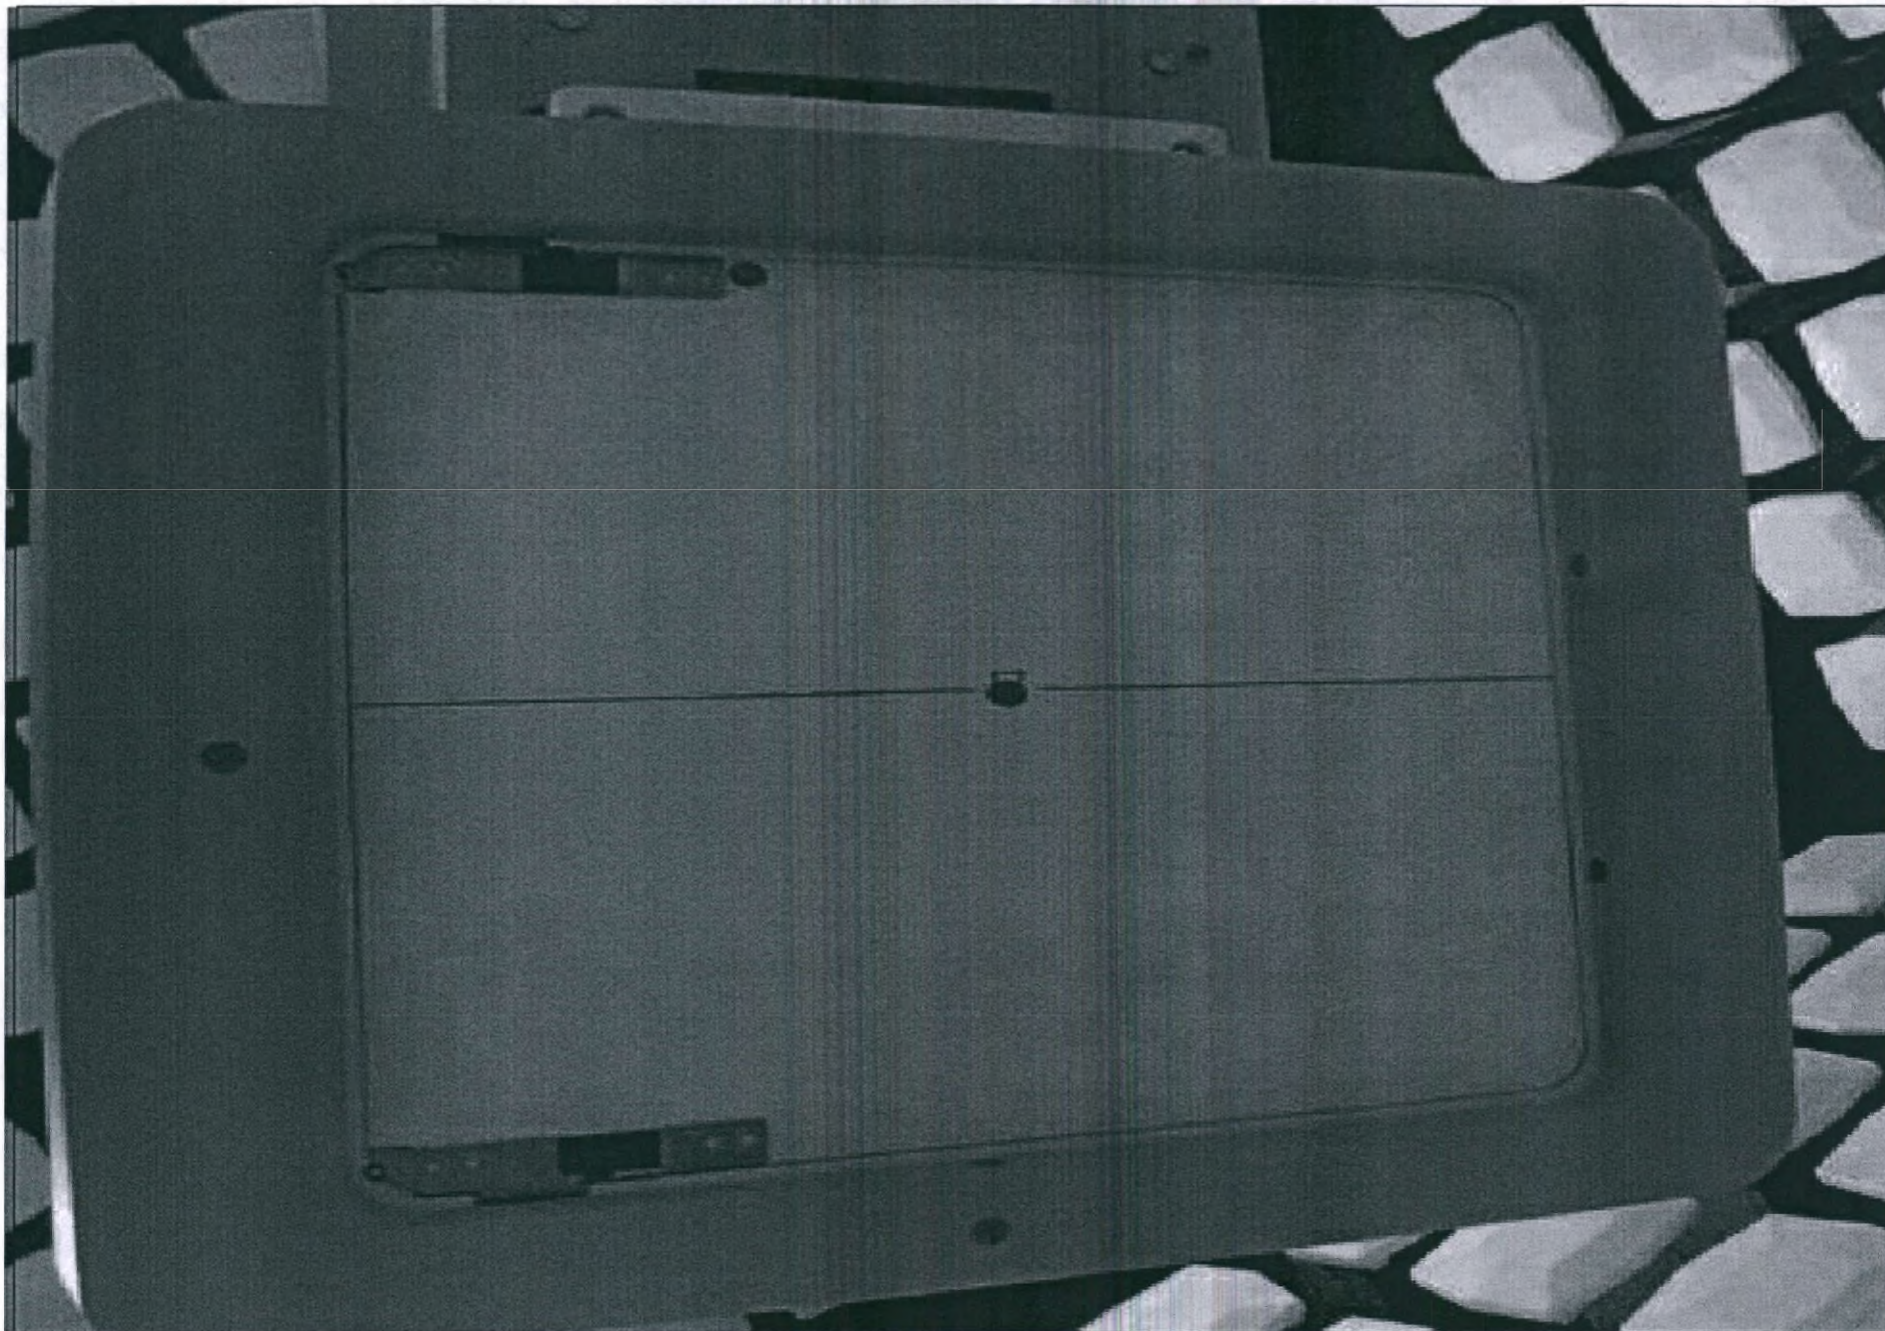


1.е. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F12.

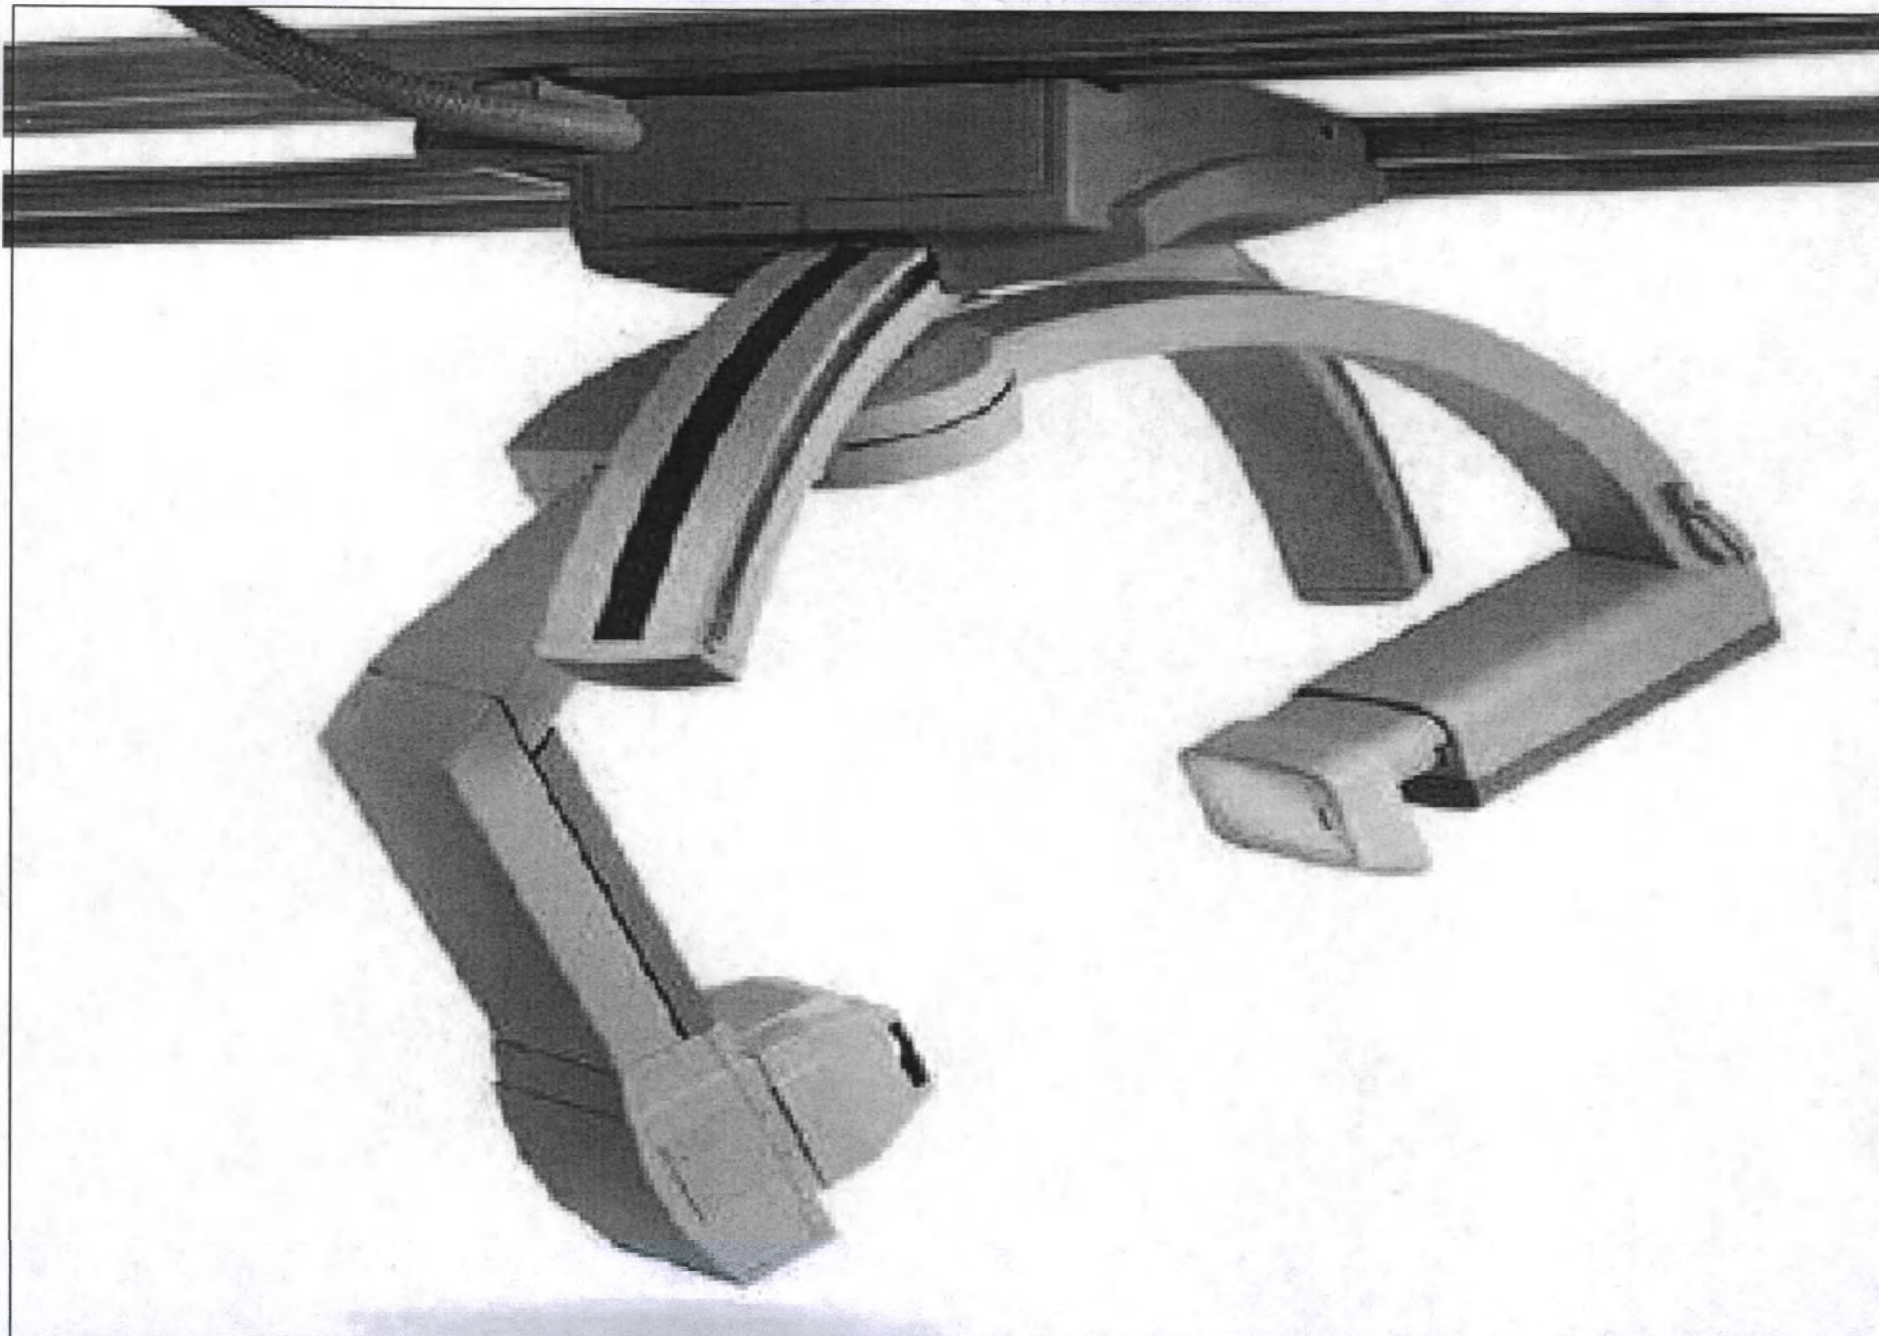


2.а. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

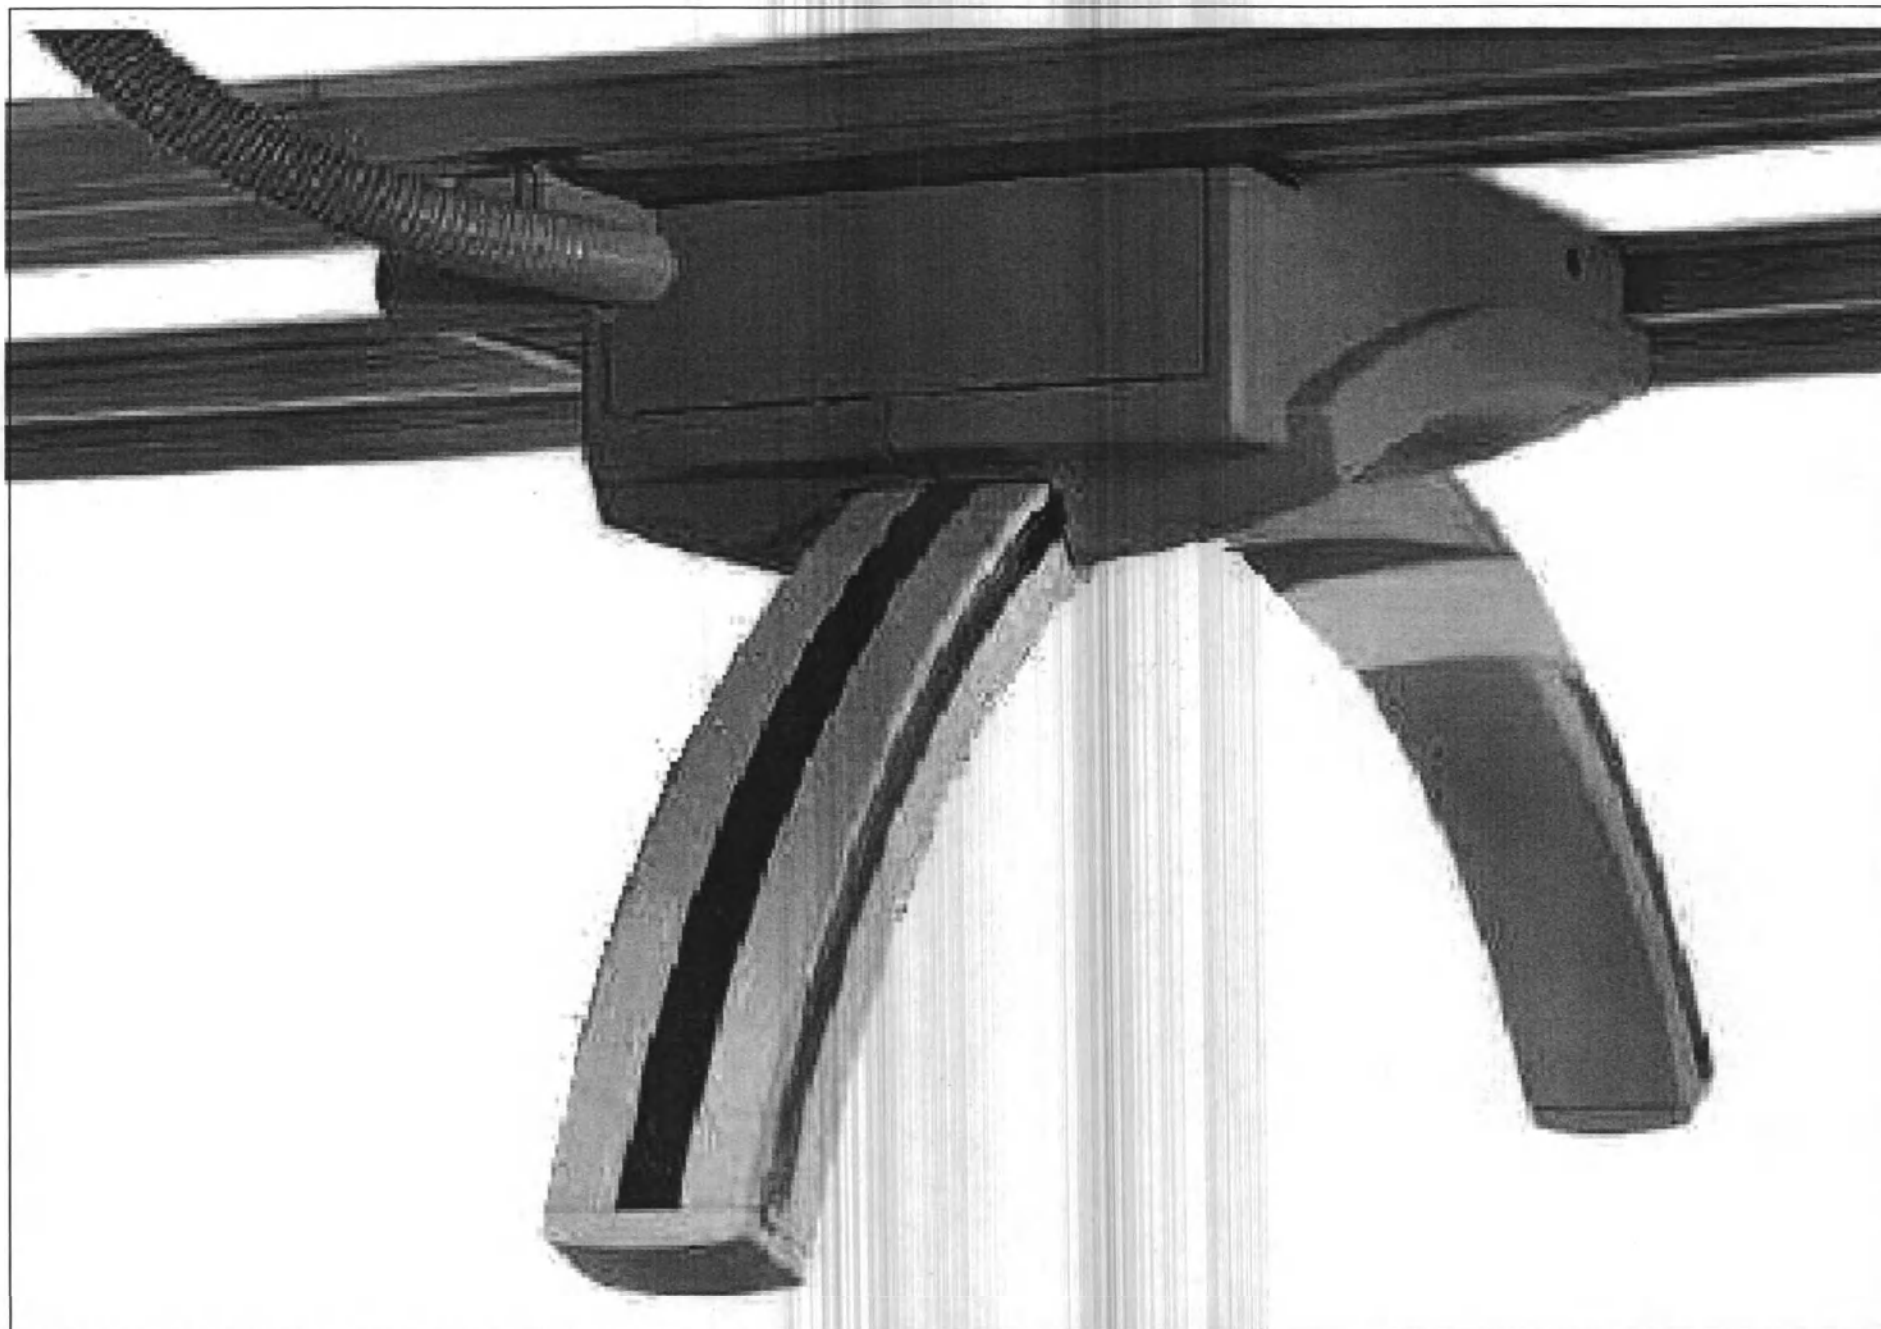


2.6. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.

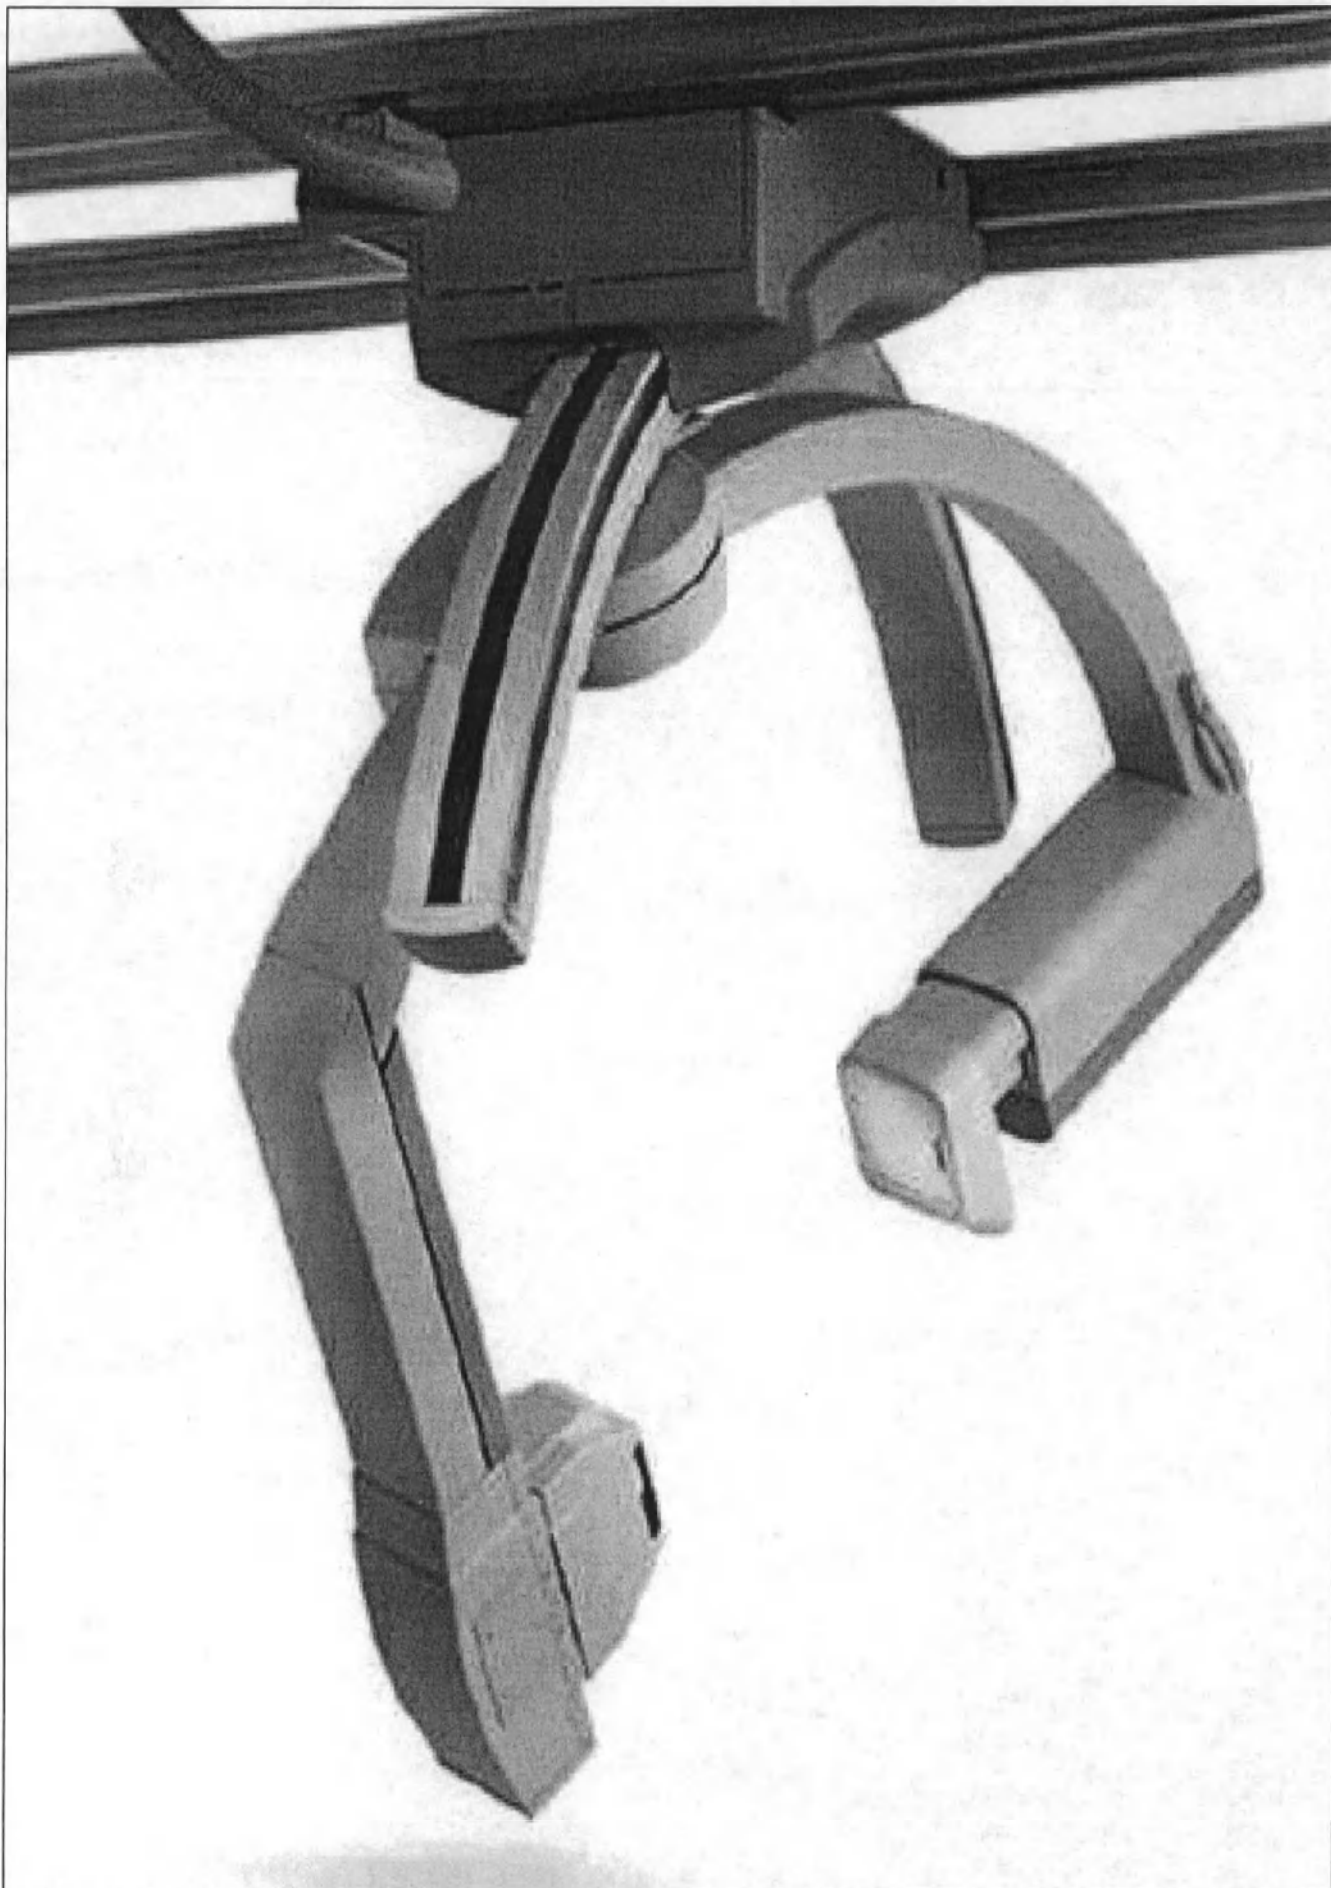


2.в.Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.

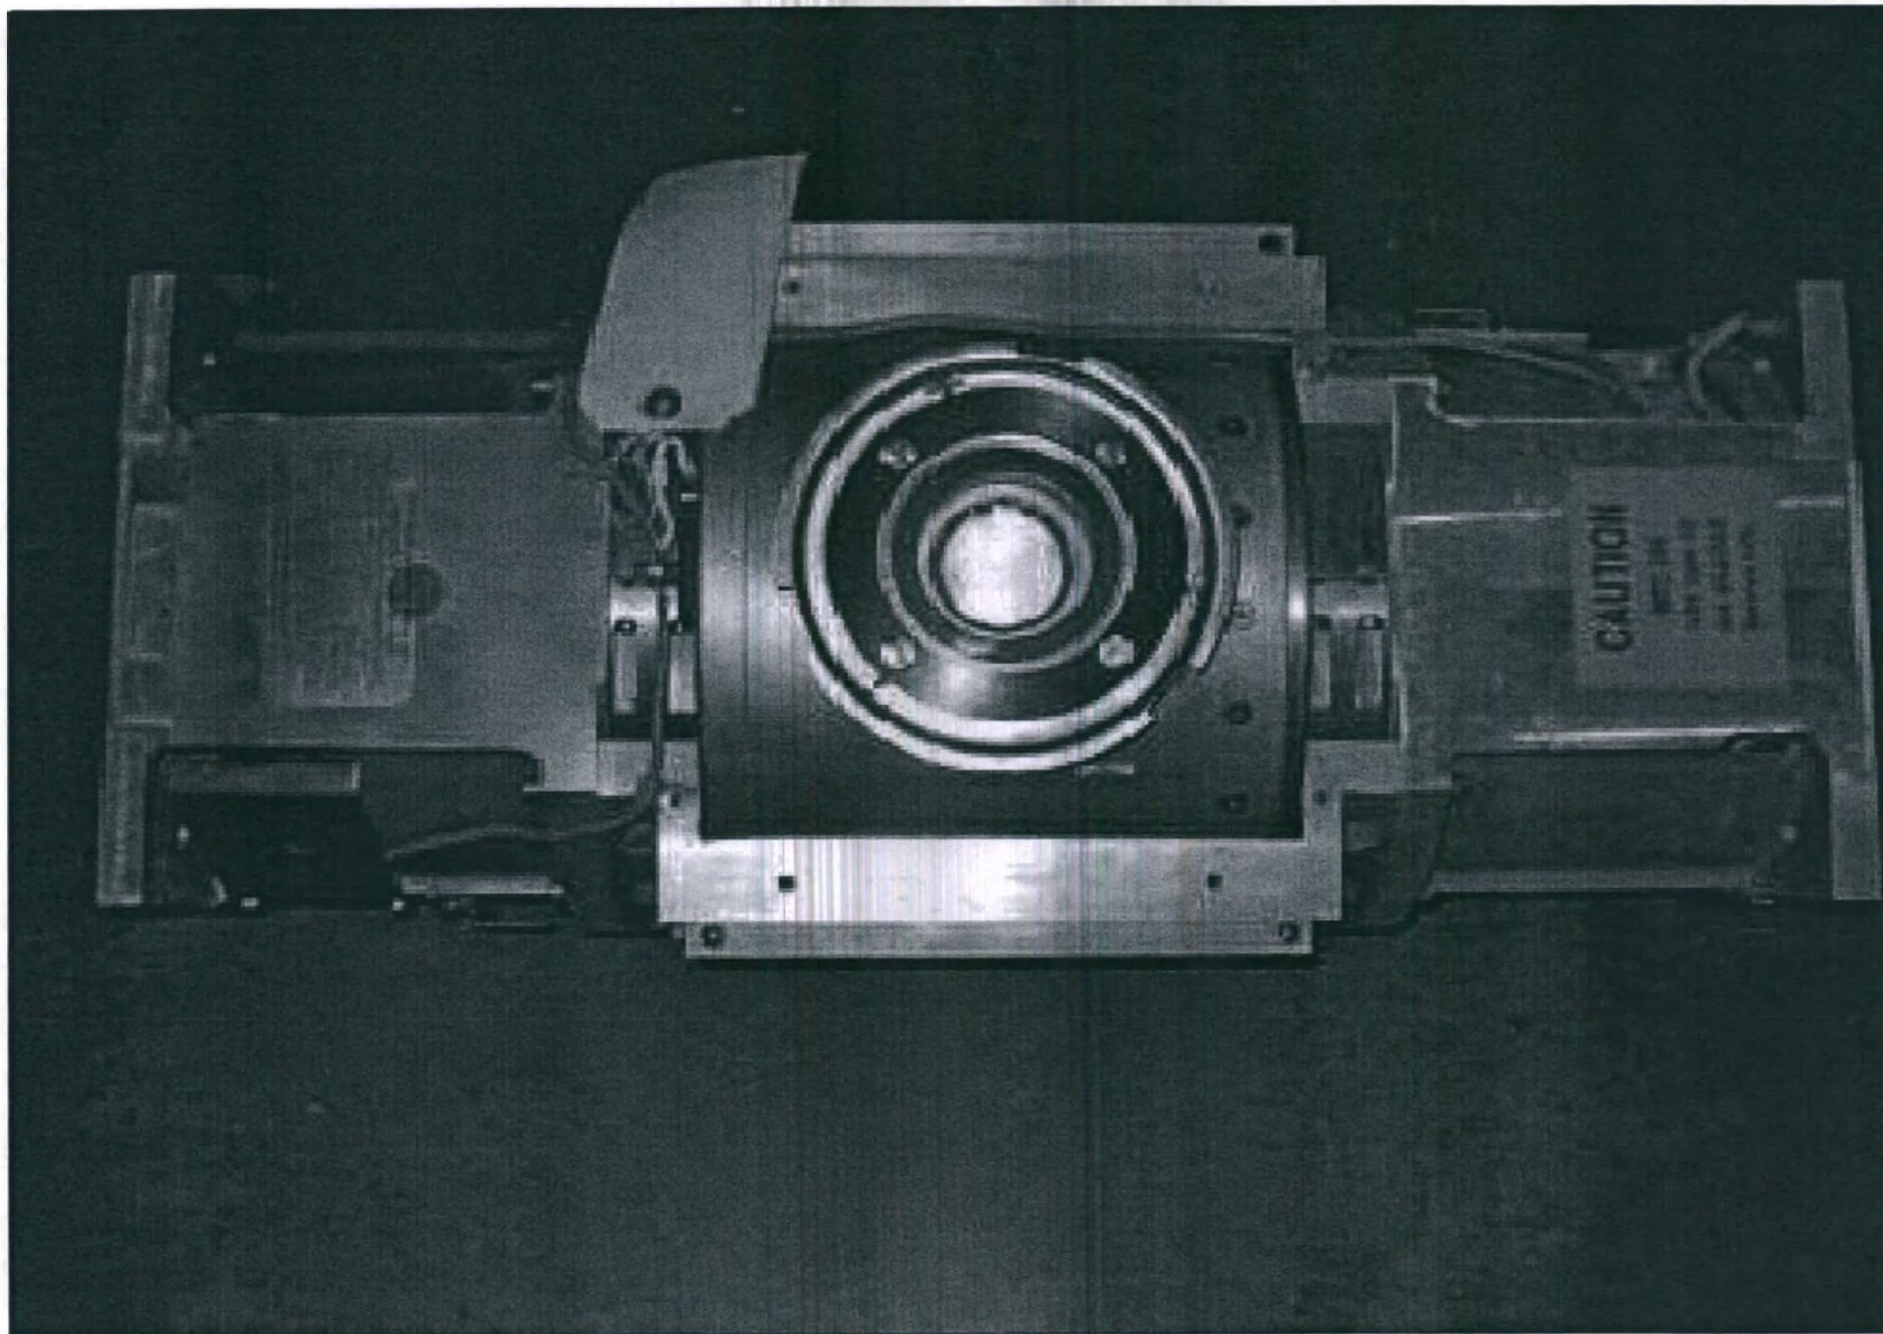


2.2. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.

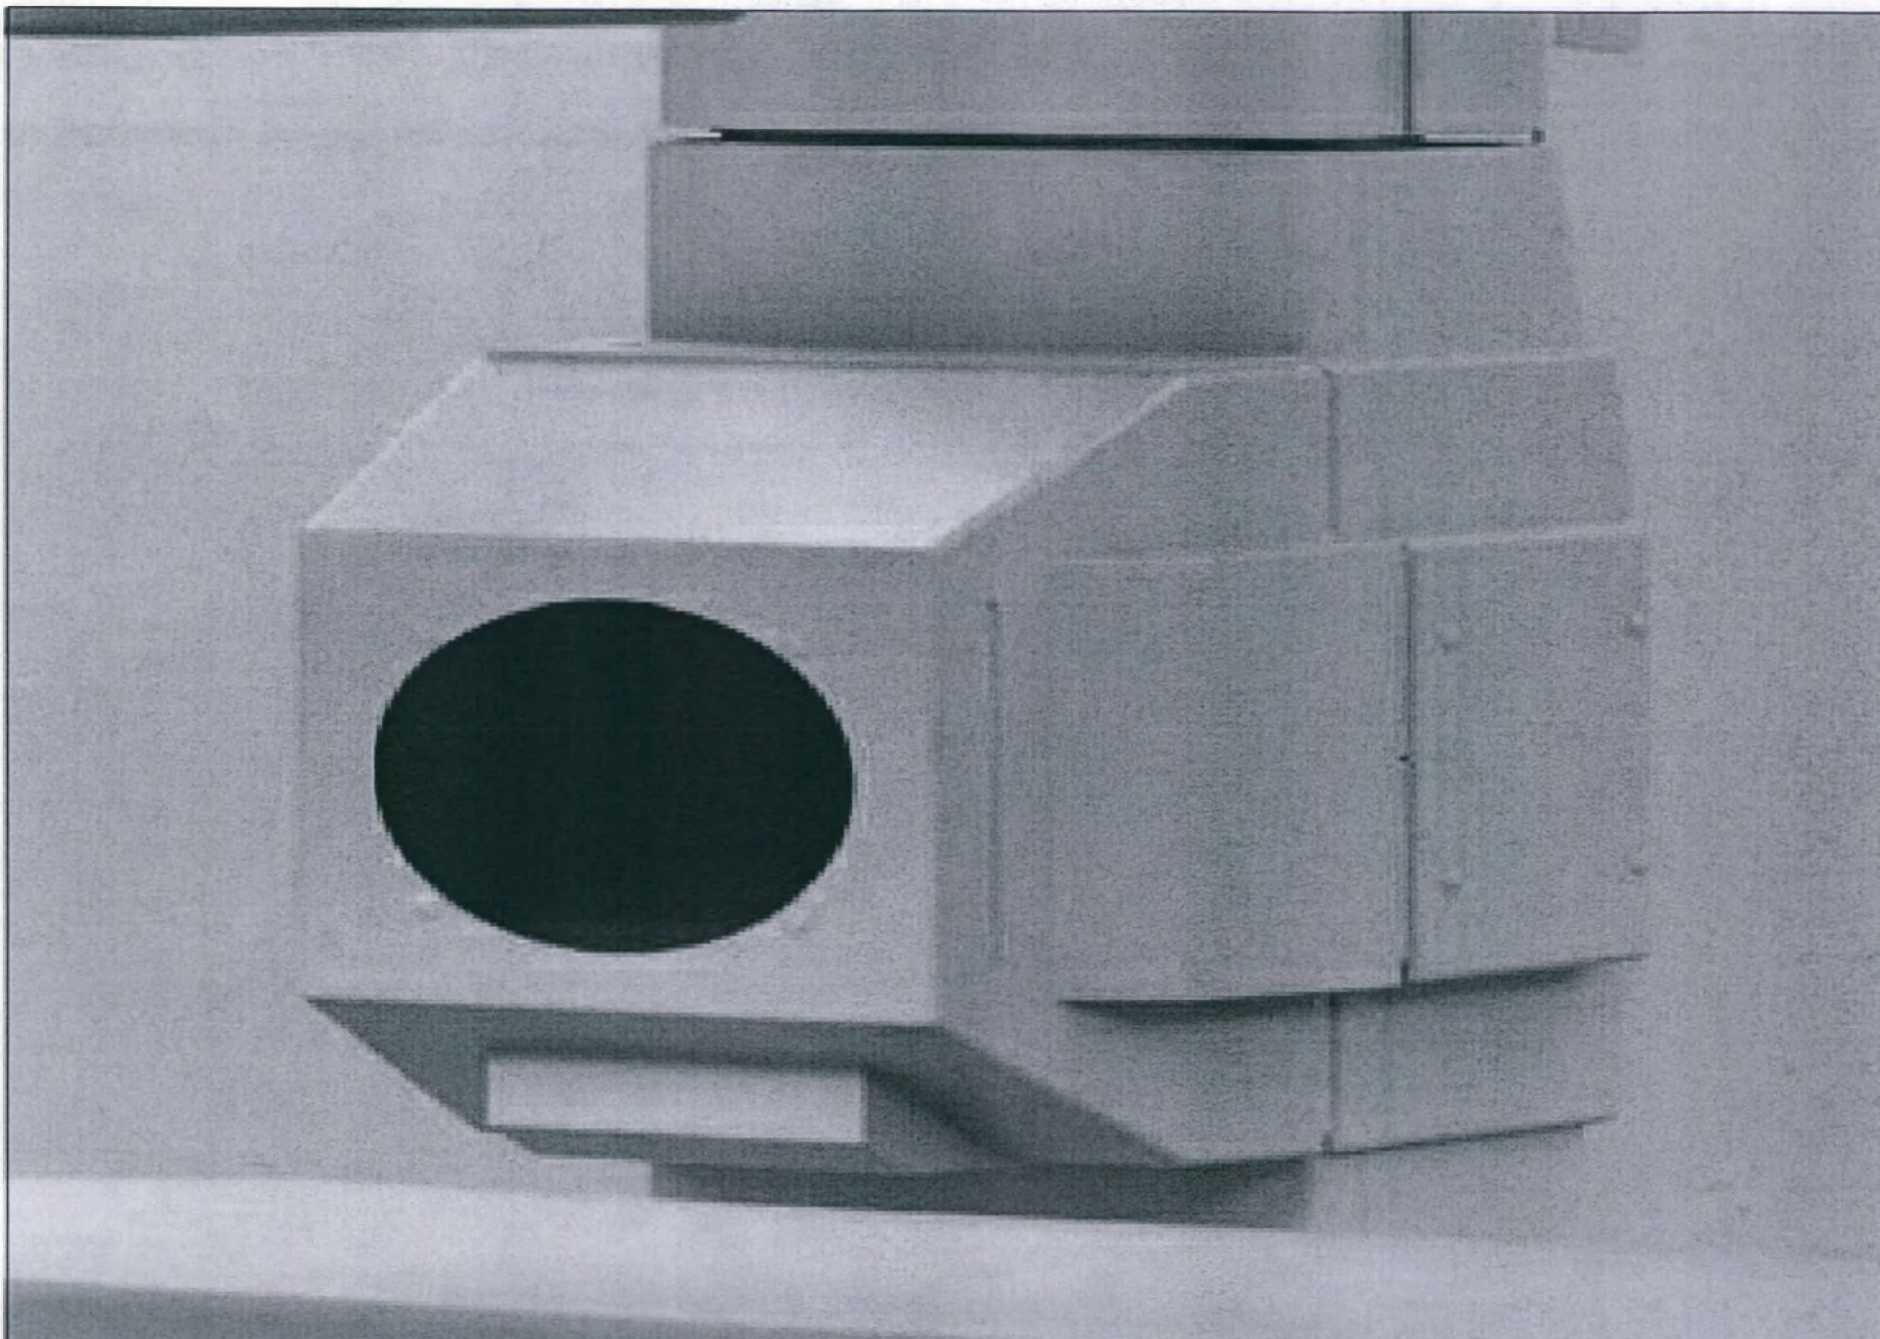


2.д. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

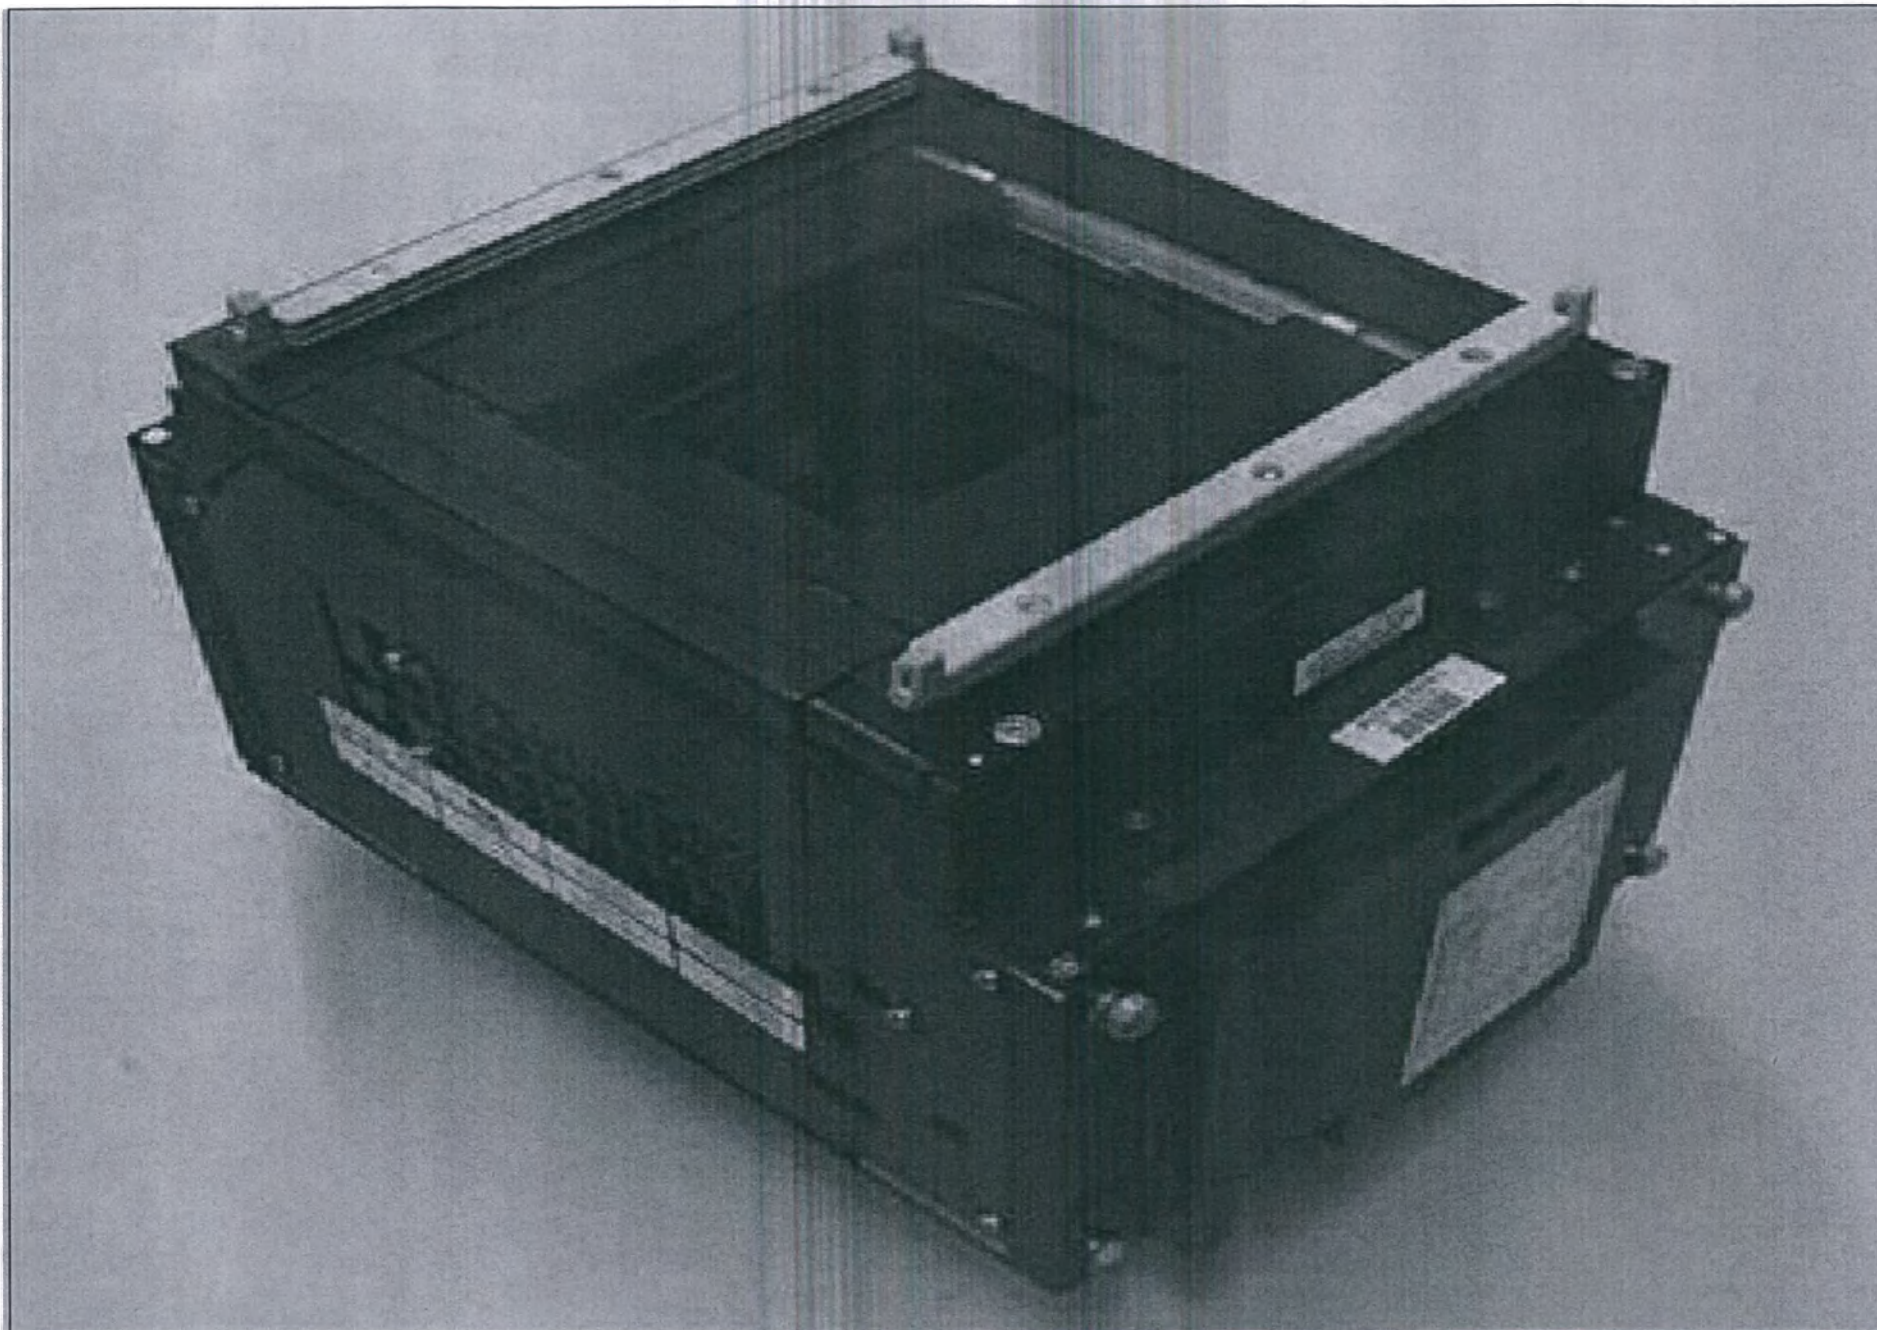


2.е. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

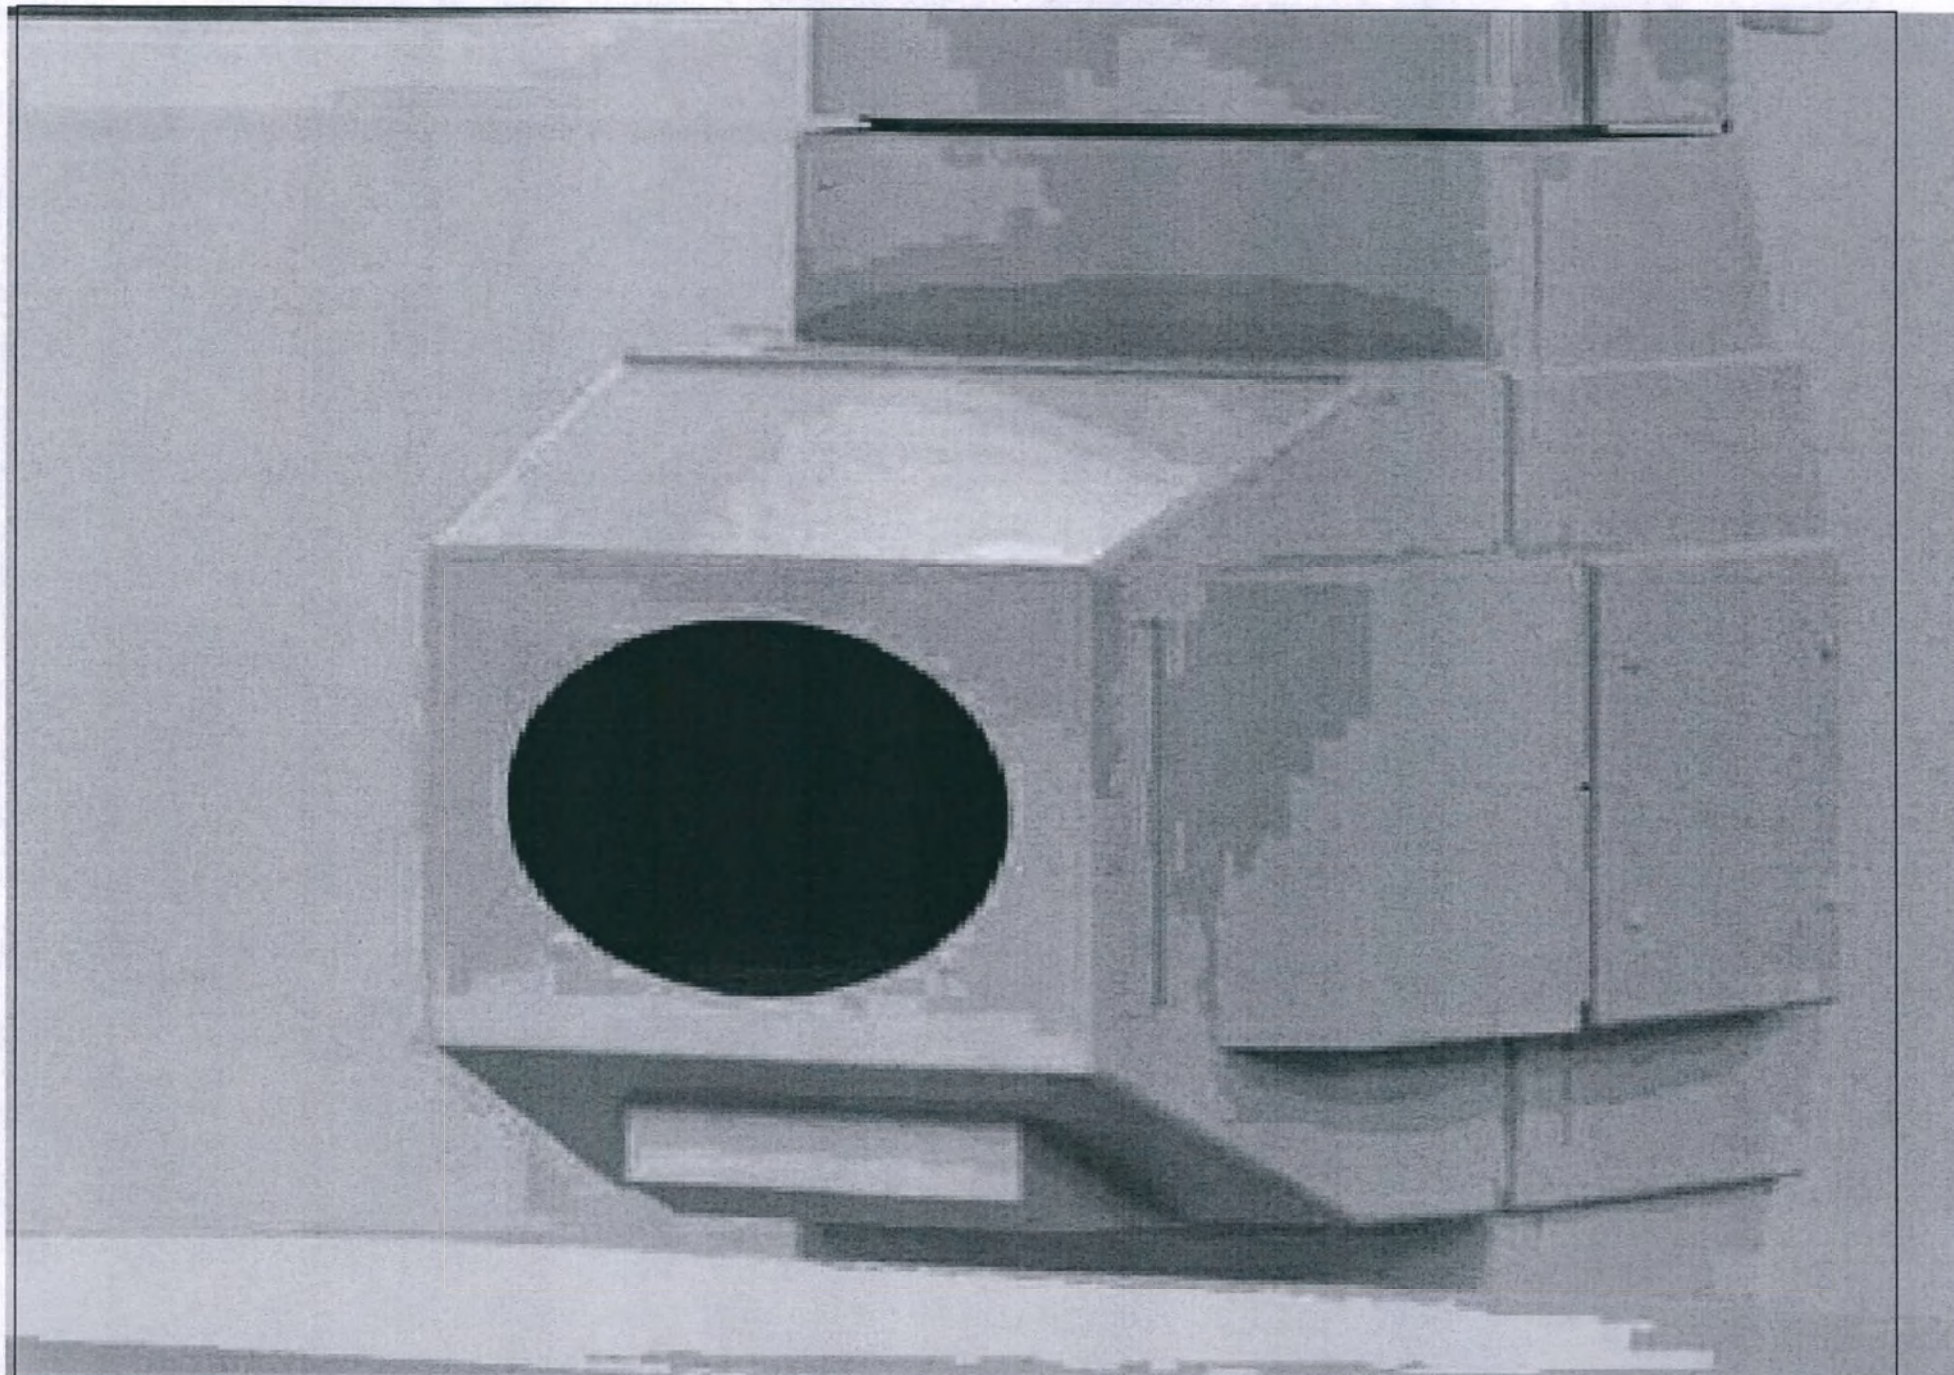


2.ж. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

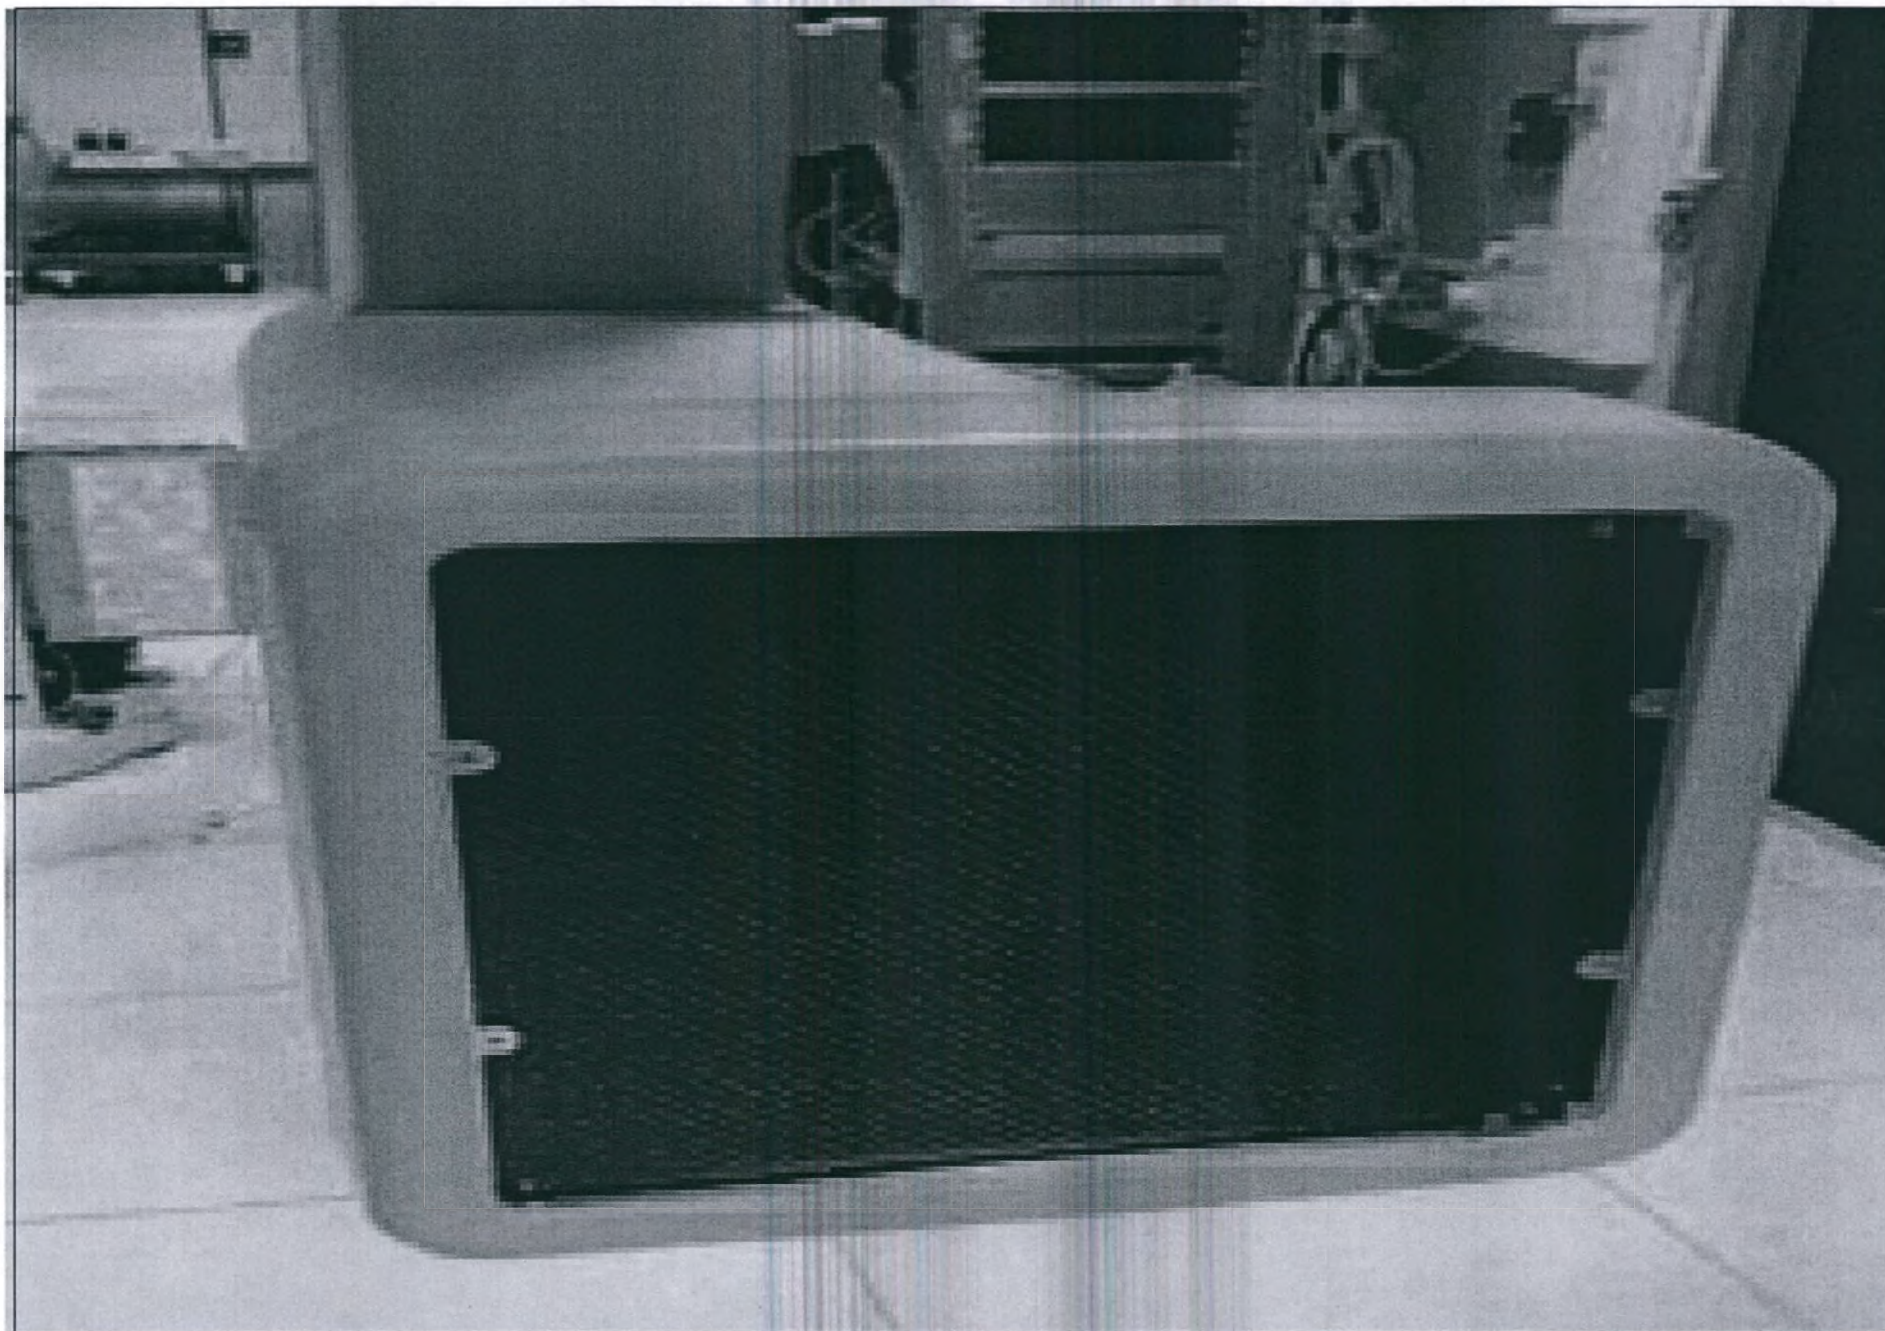


2.3. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

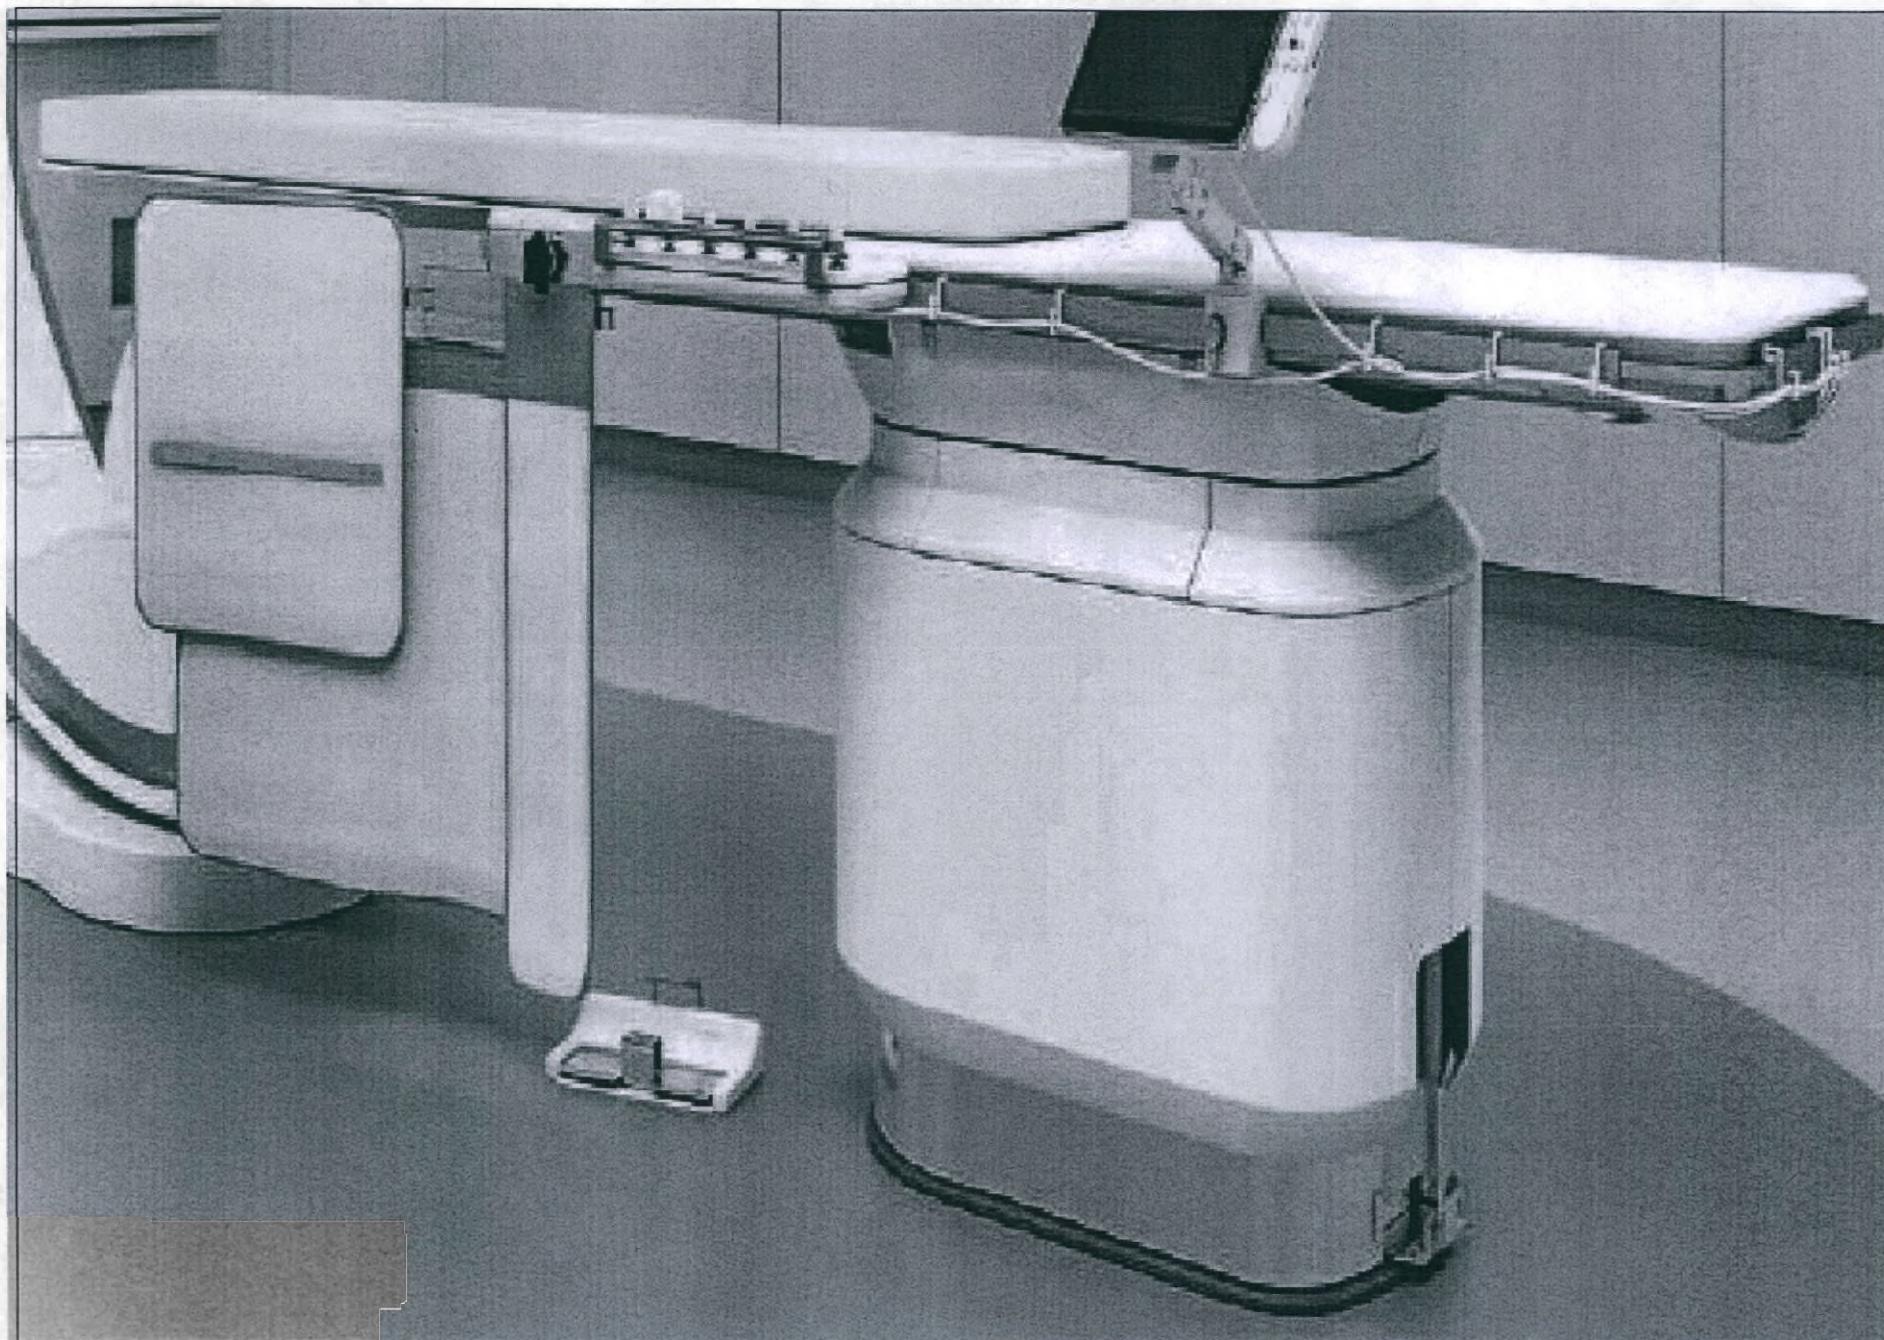


3.а. Стол пациента, варианты исполнения: *Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.*

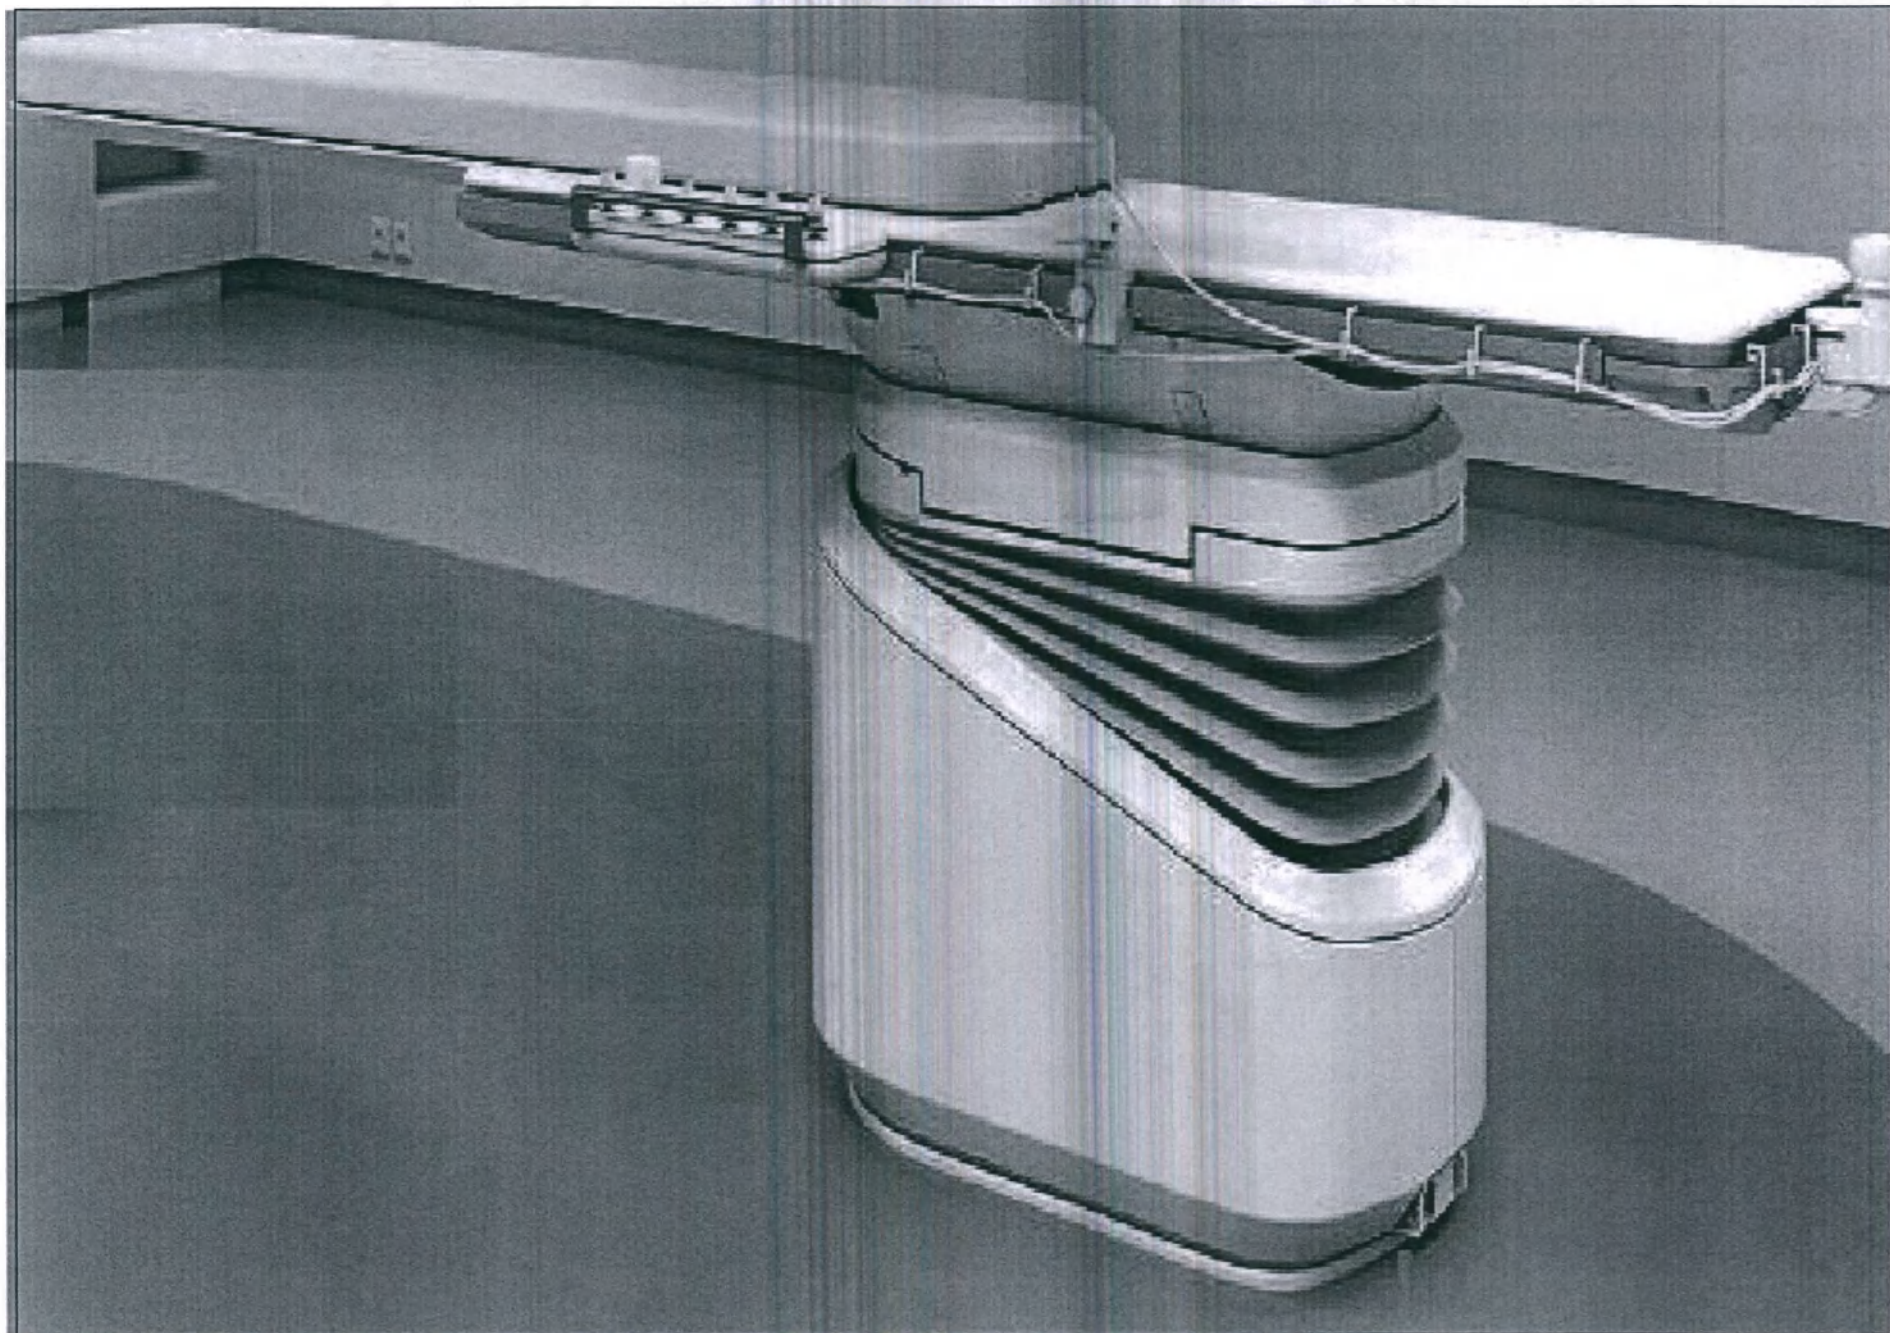


3.6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

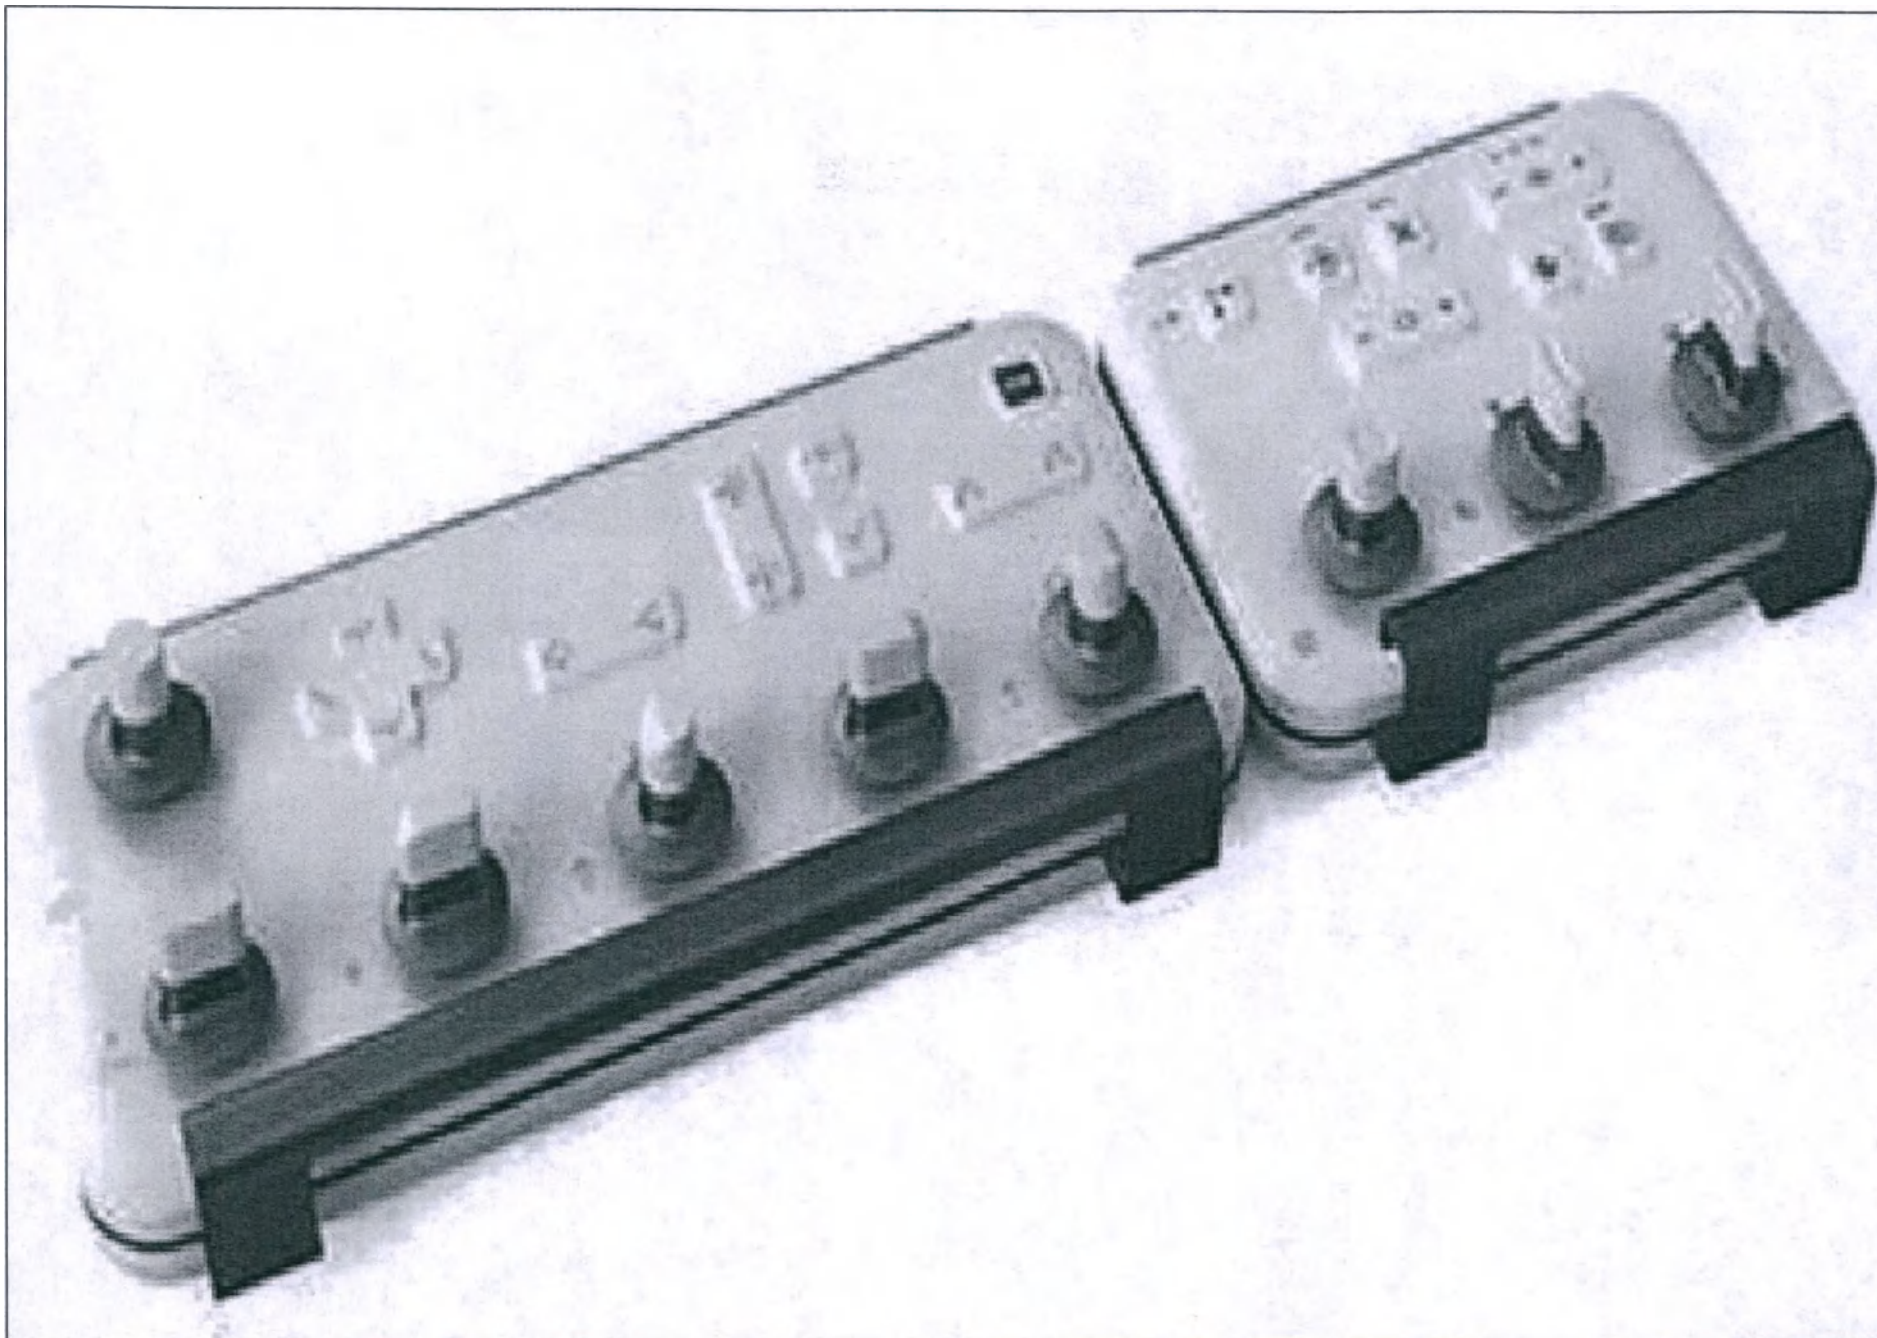


4. Модуль управления, не более 4шт.

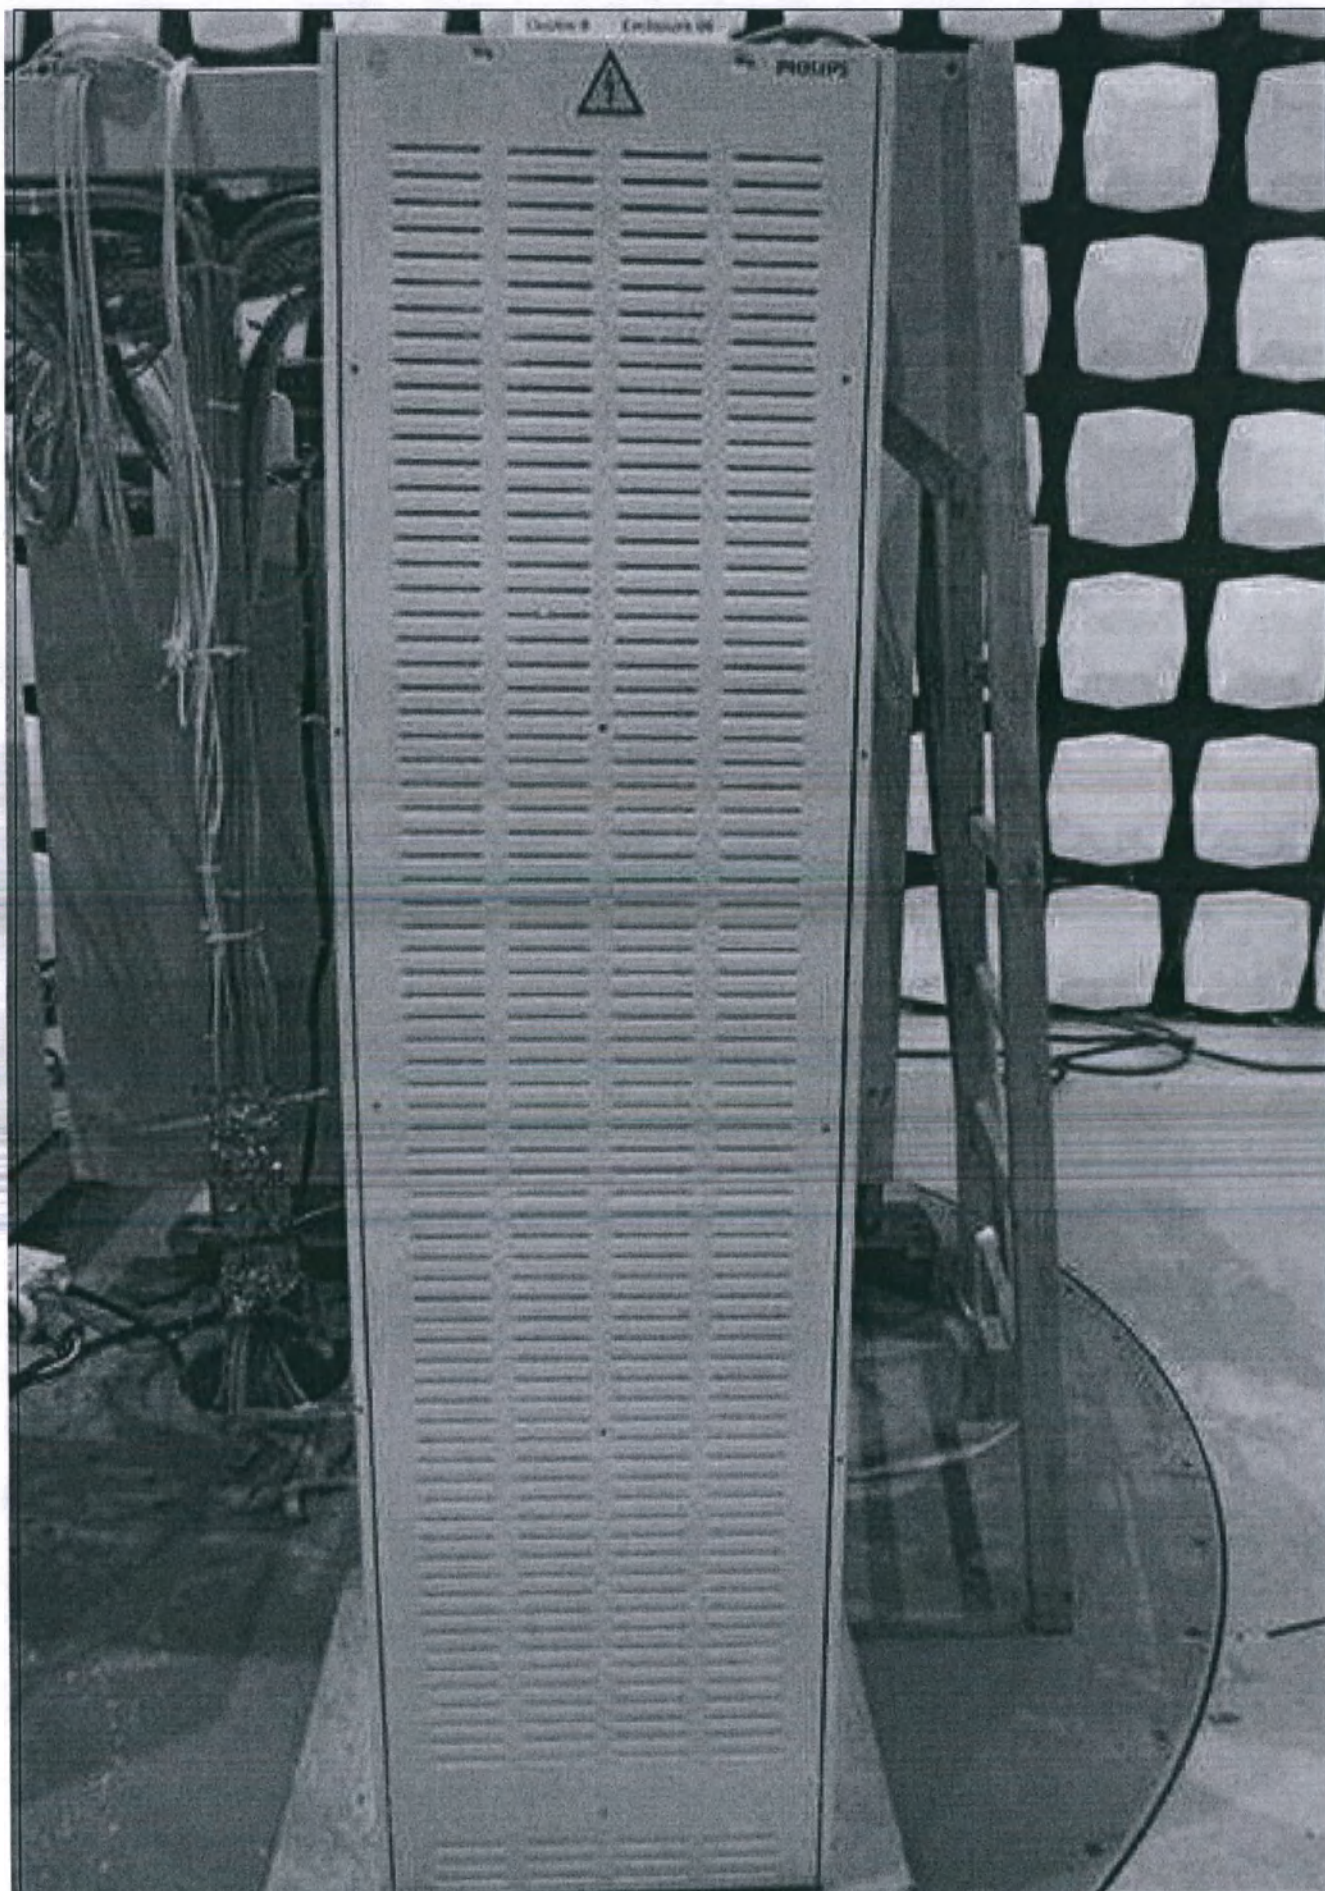


5.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

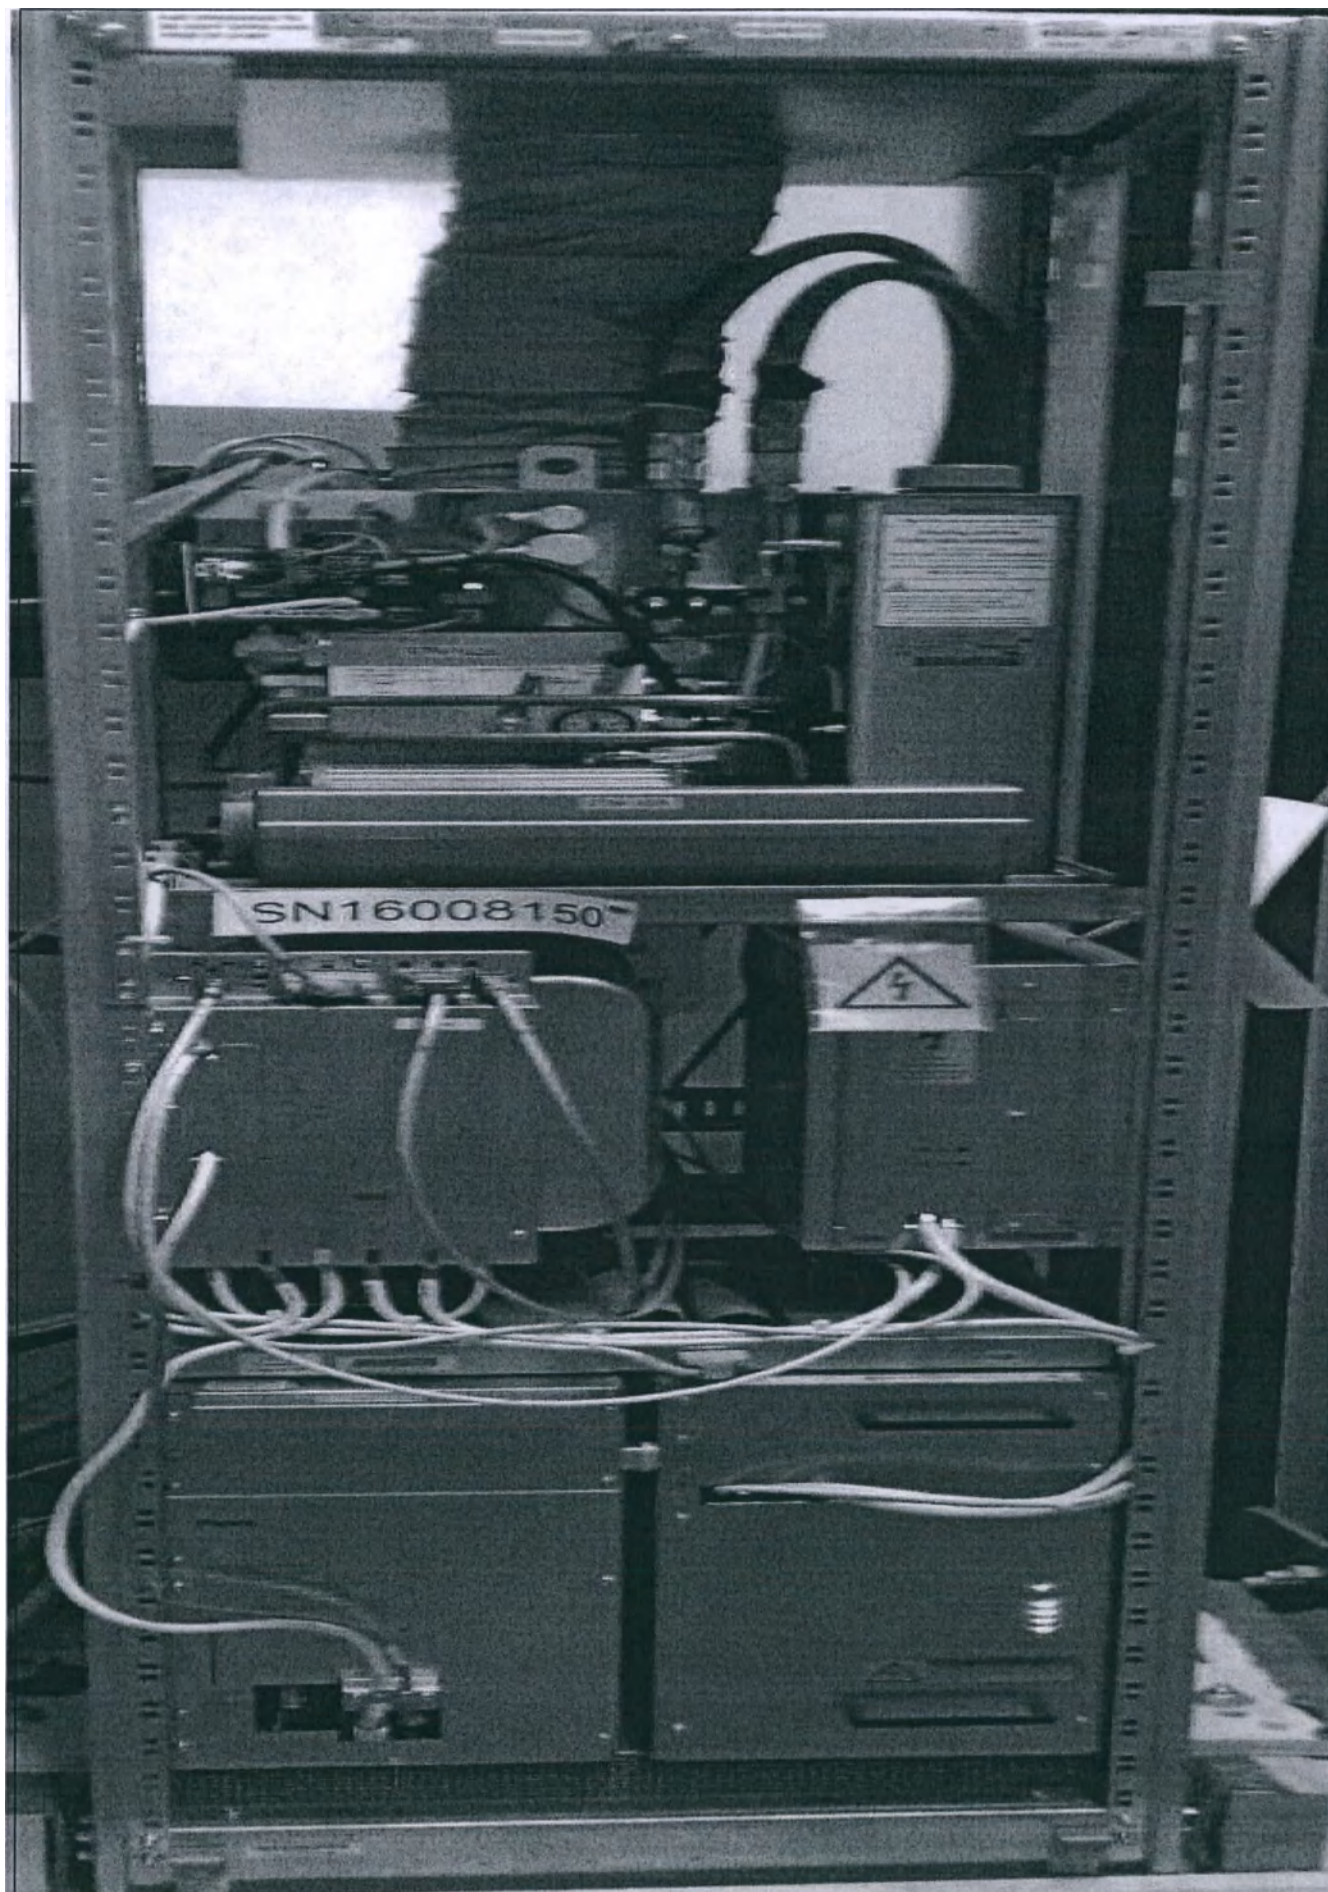


5.6. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

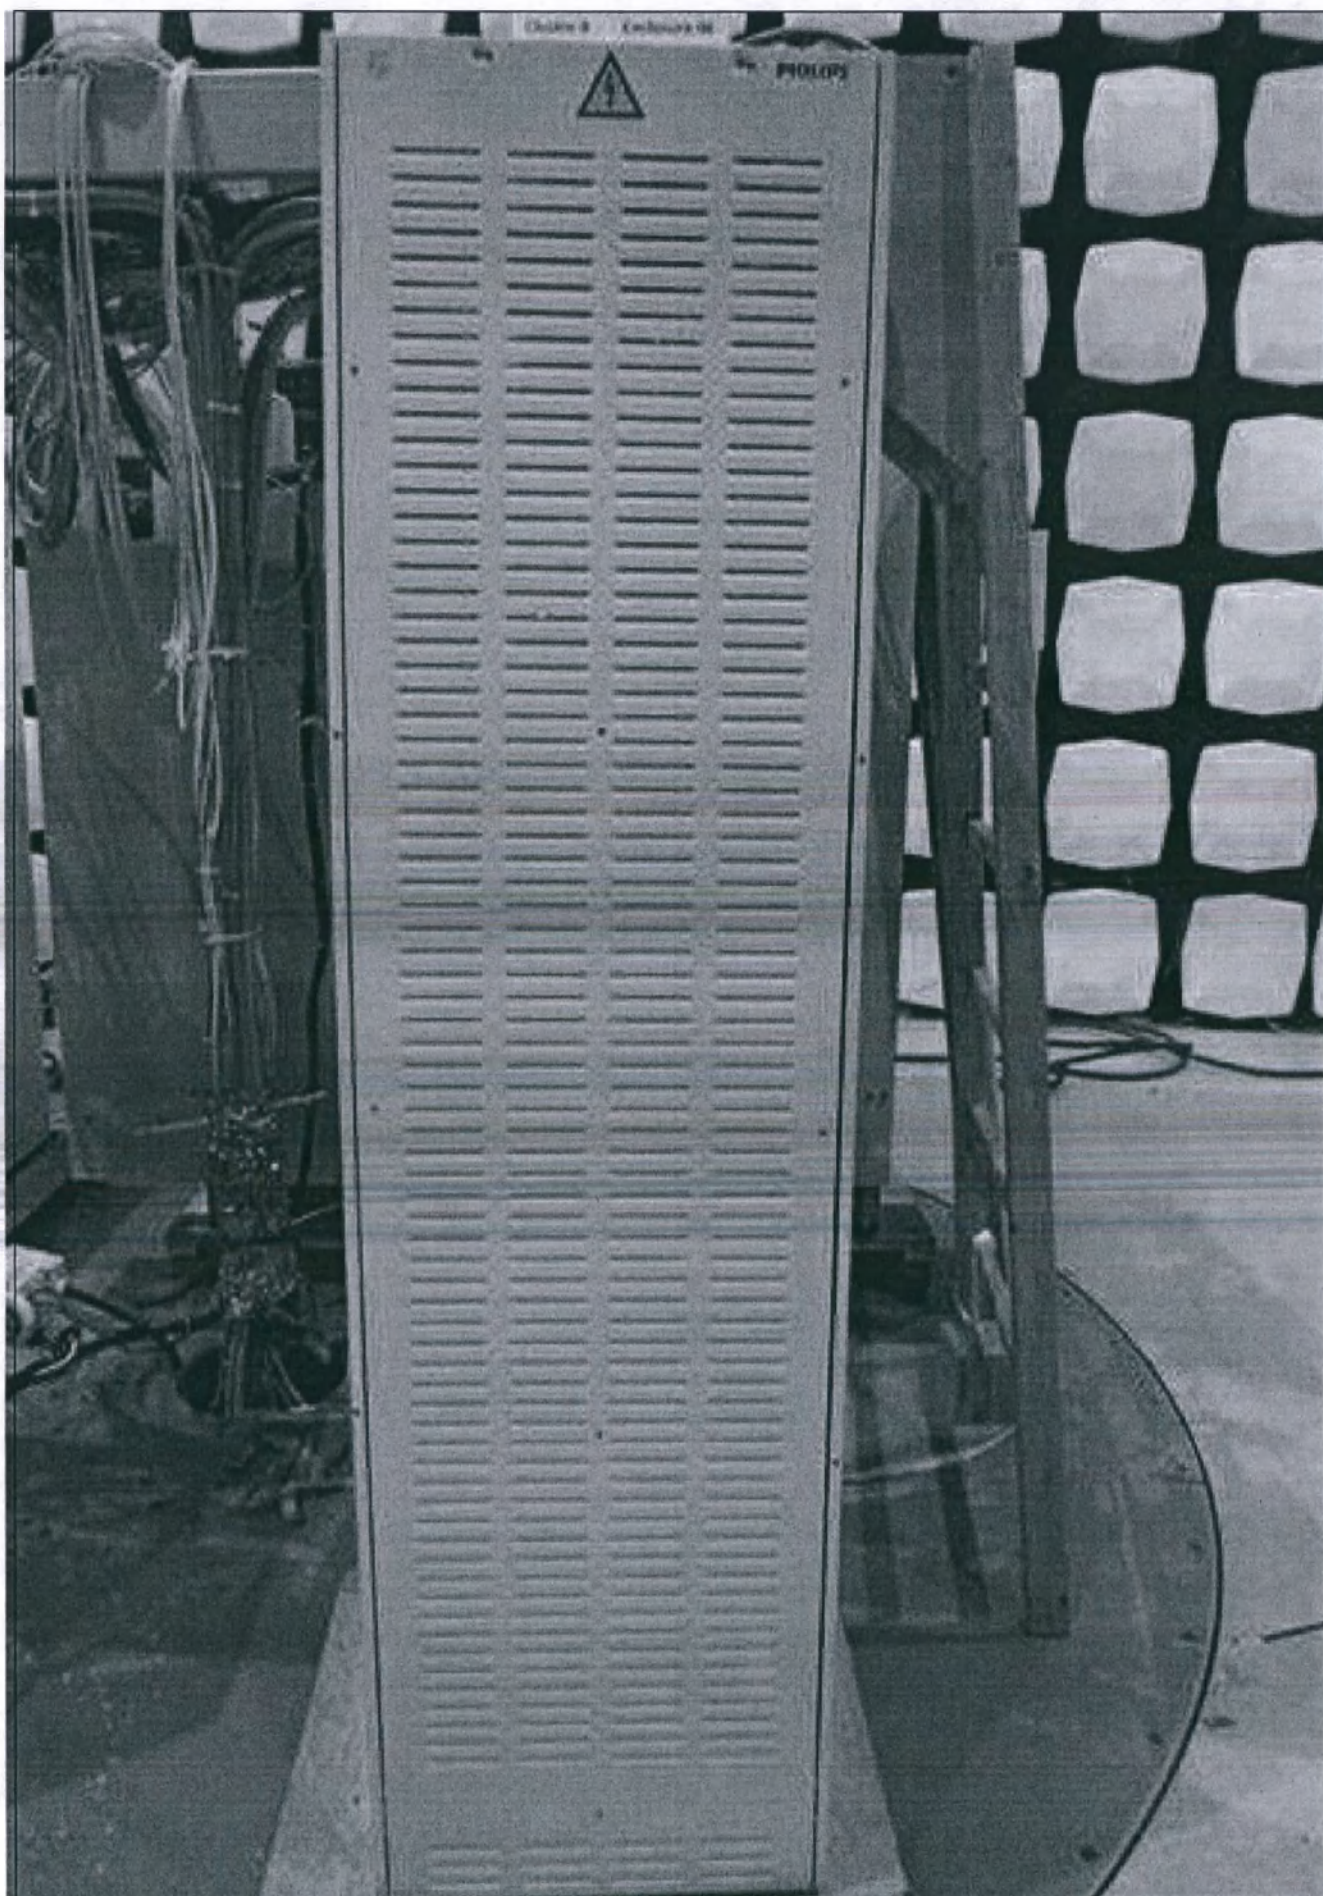


6.а. Шкаф управления.

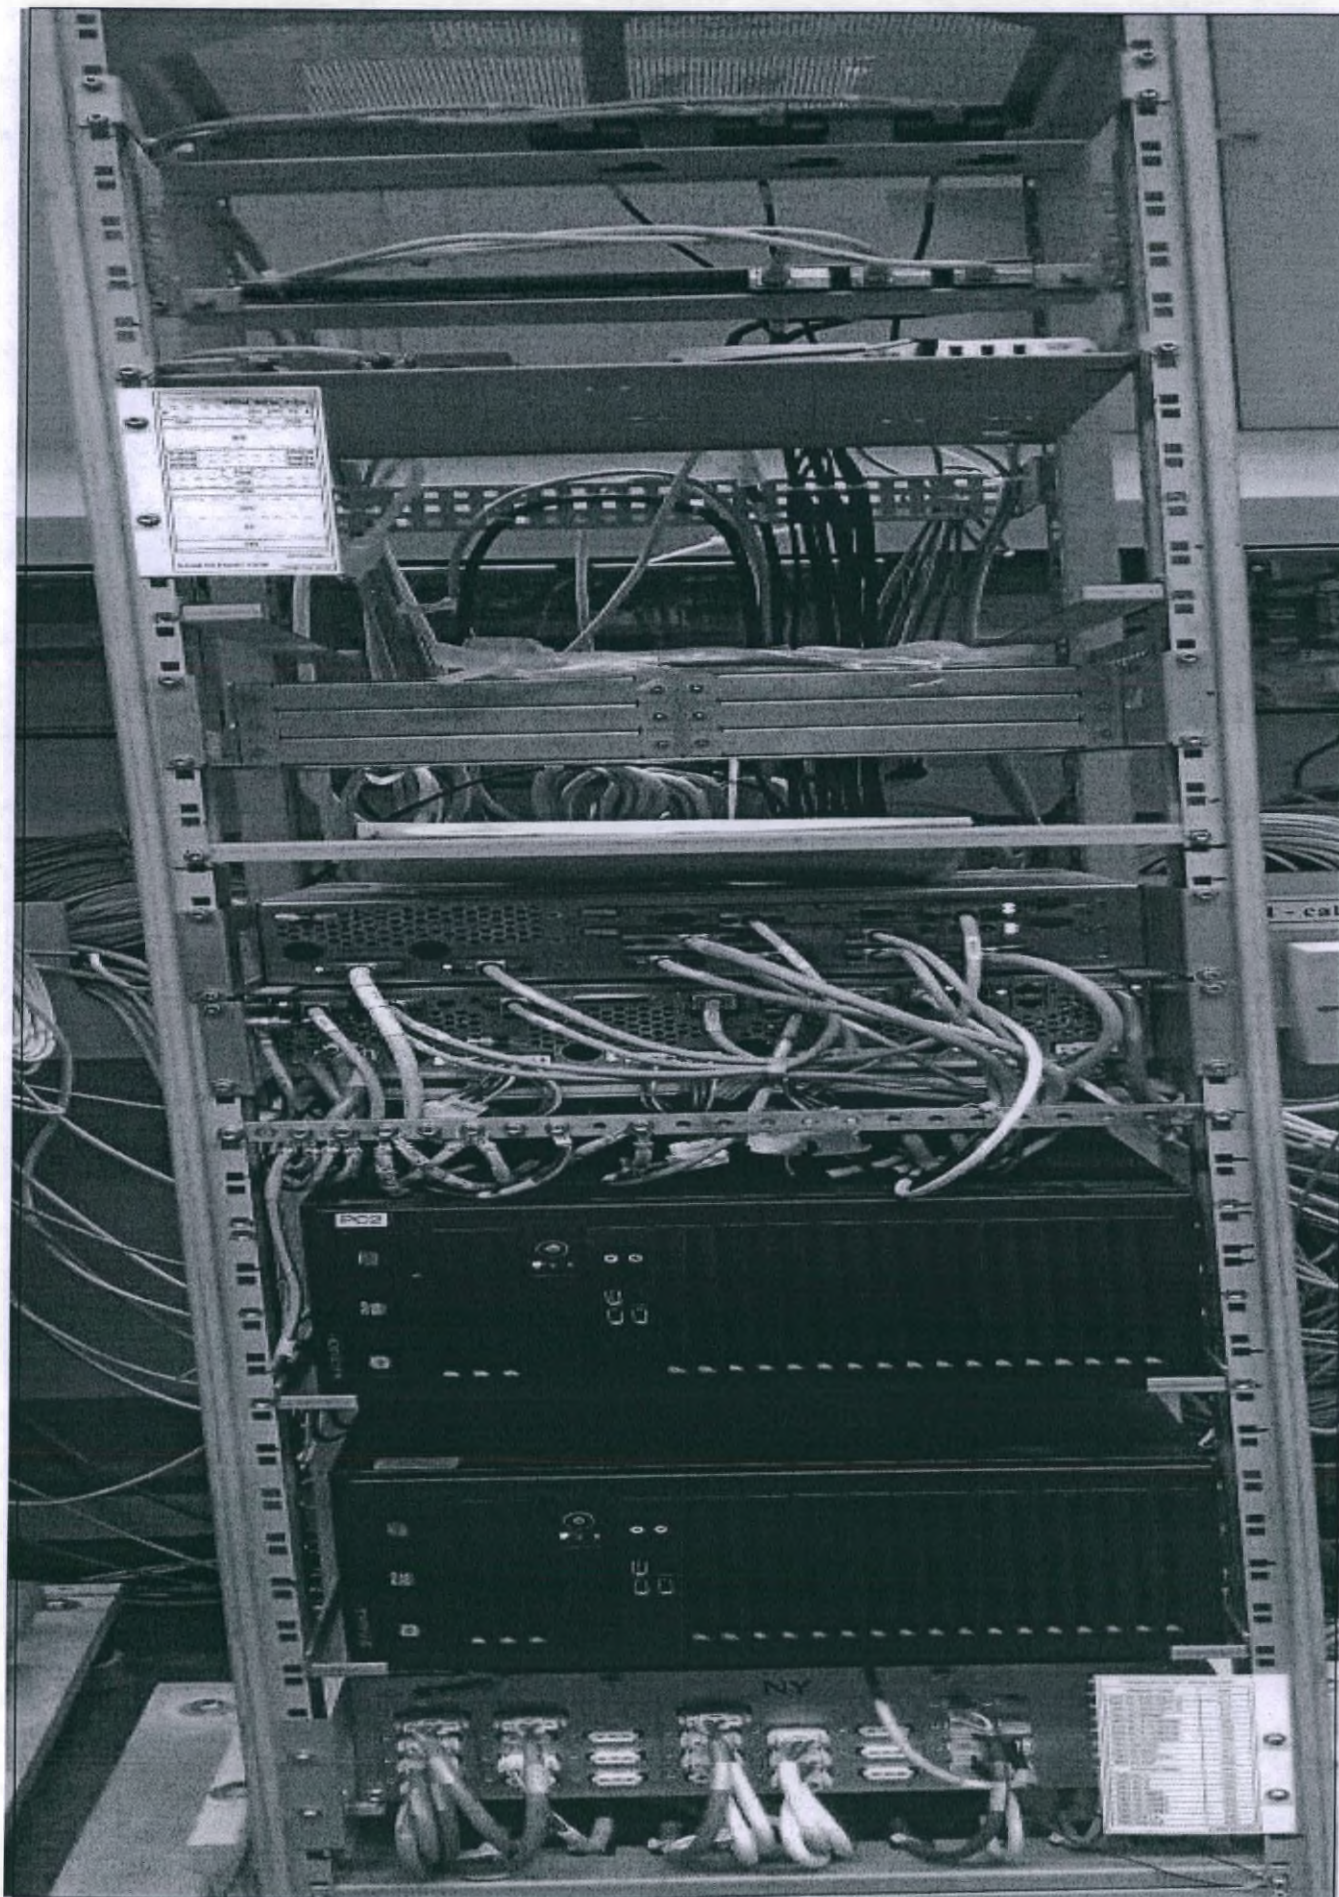

6.6. Шкаф управления.

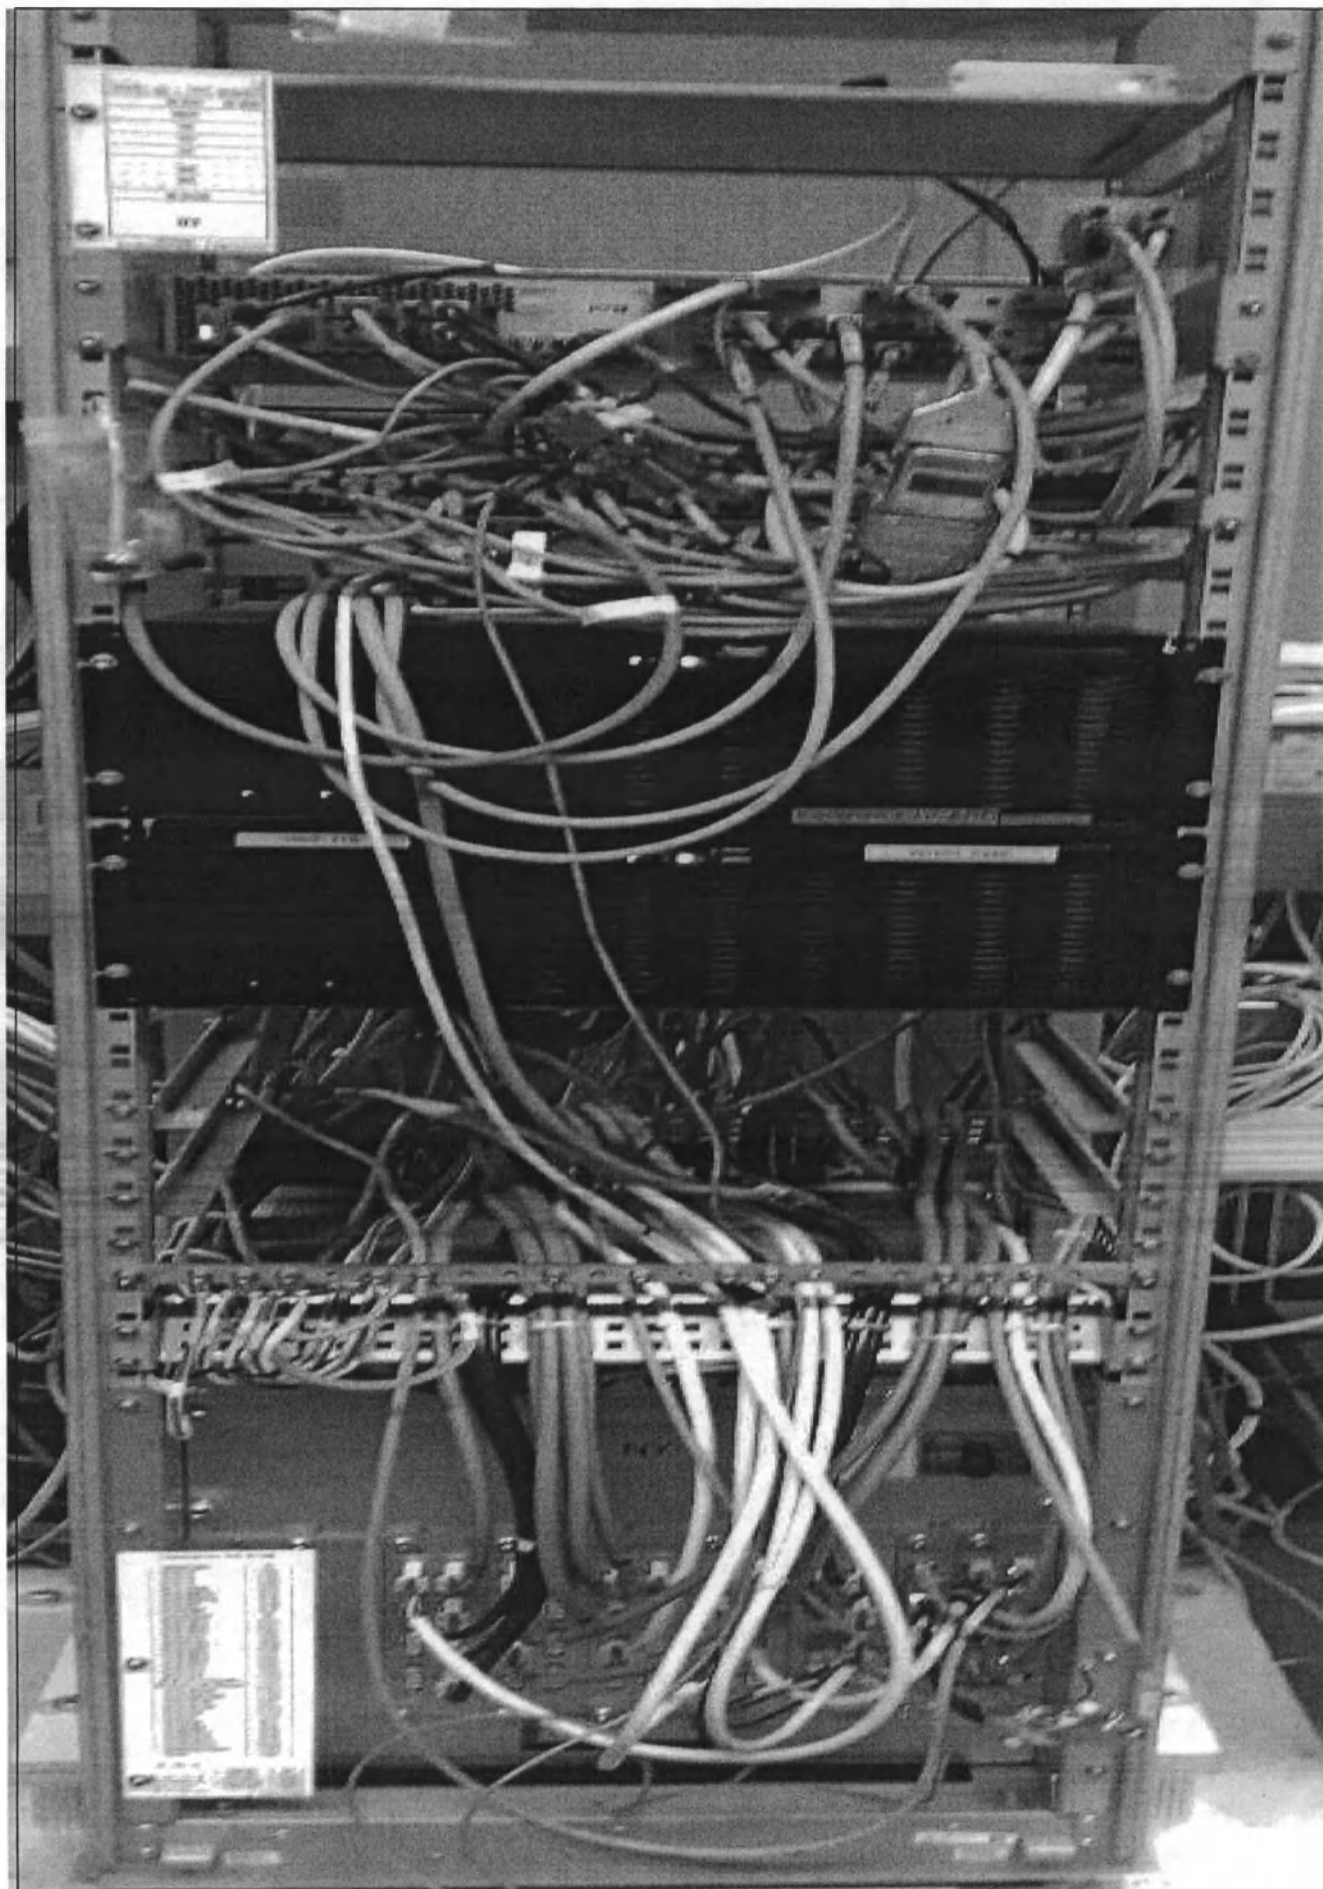

7.а. Распределительный щит.

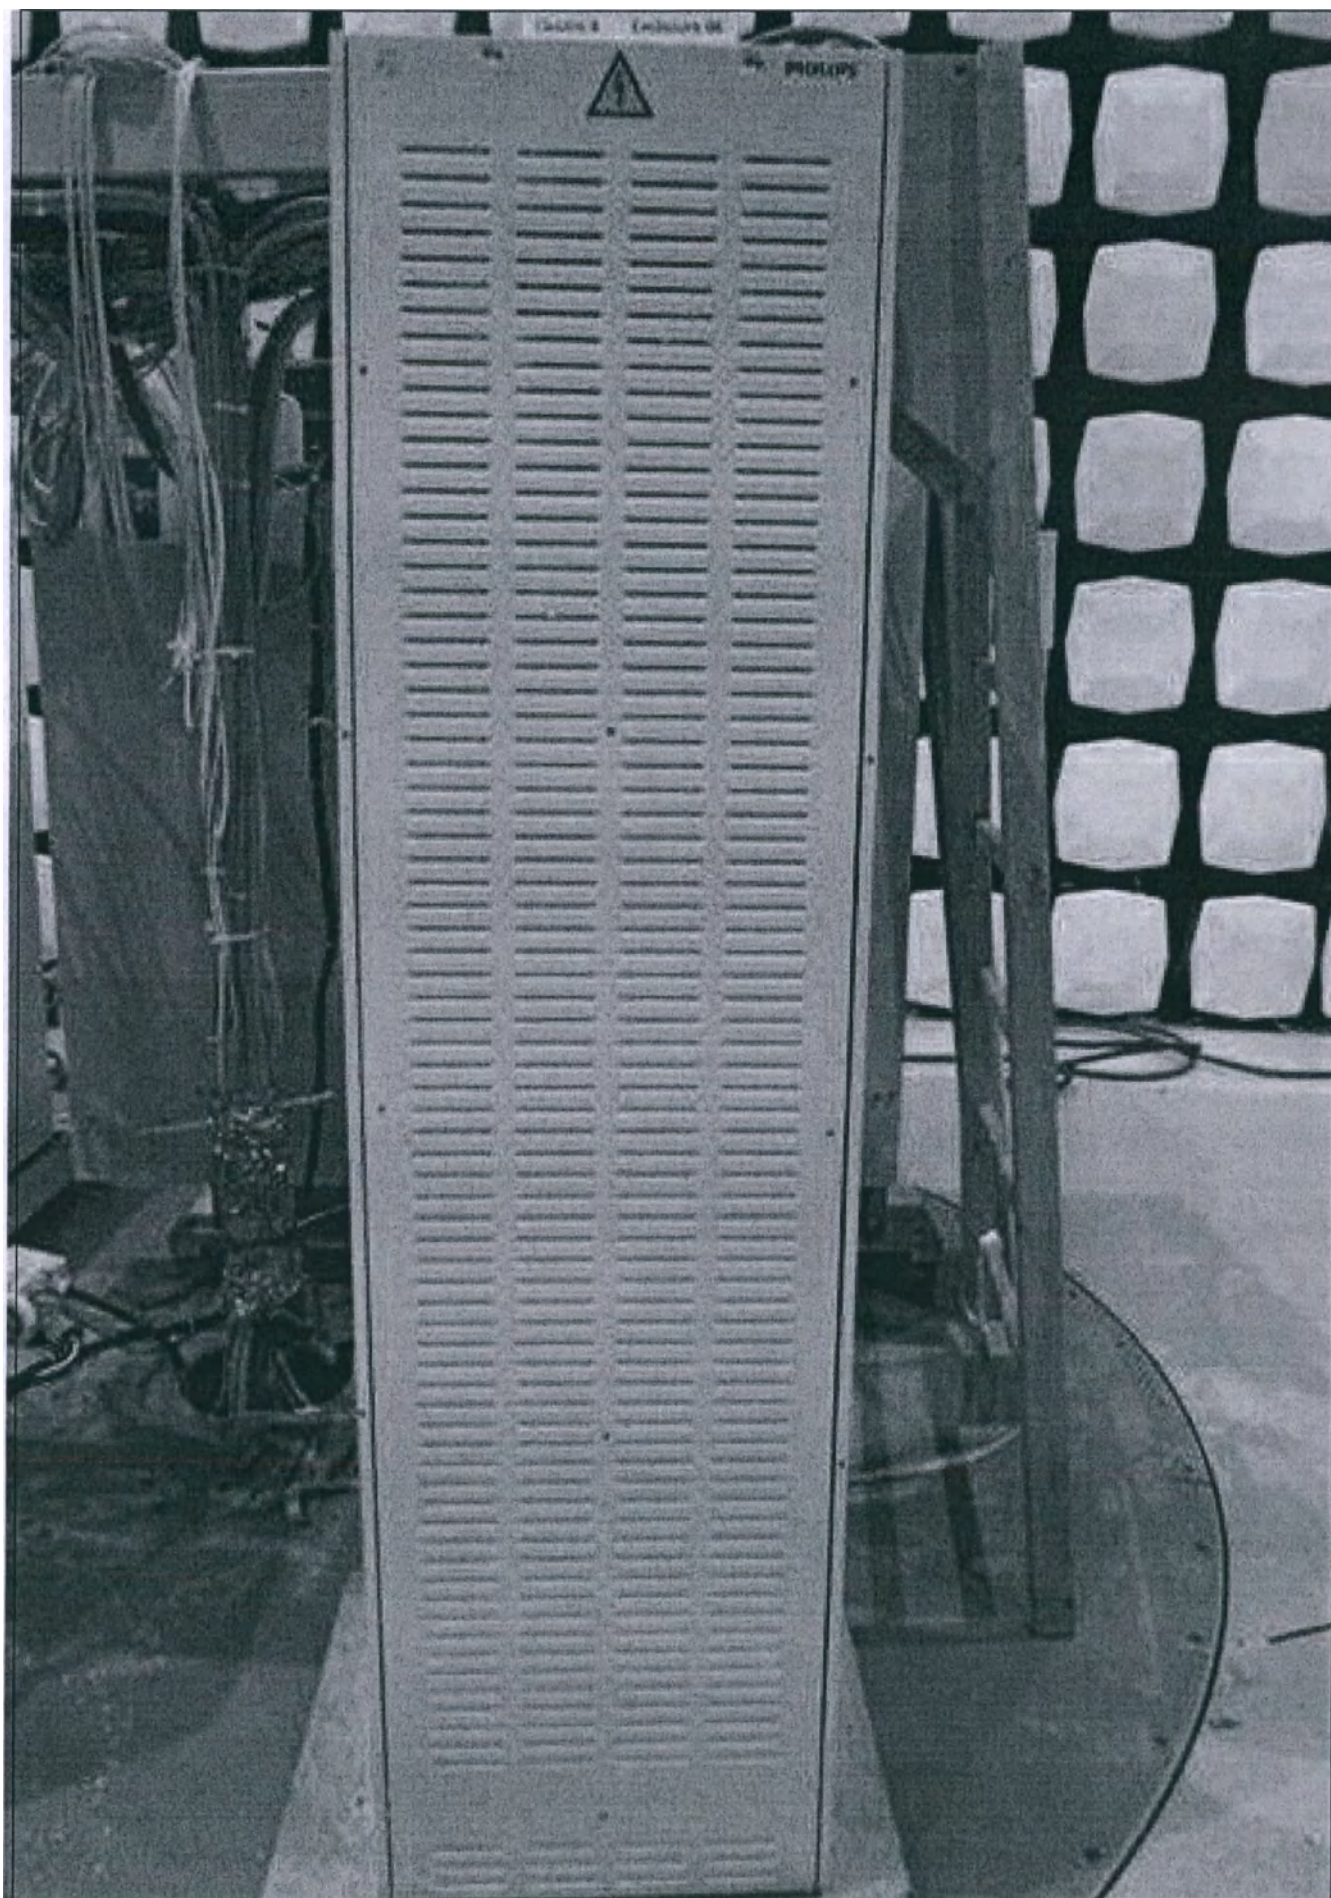


7.6. Распределительный щит.




8. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.



9. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

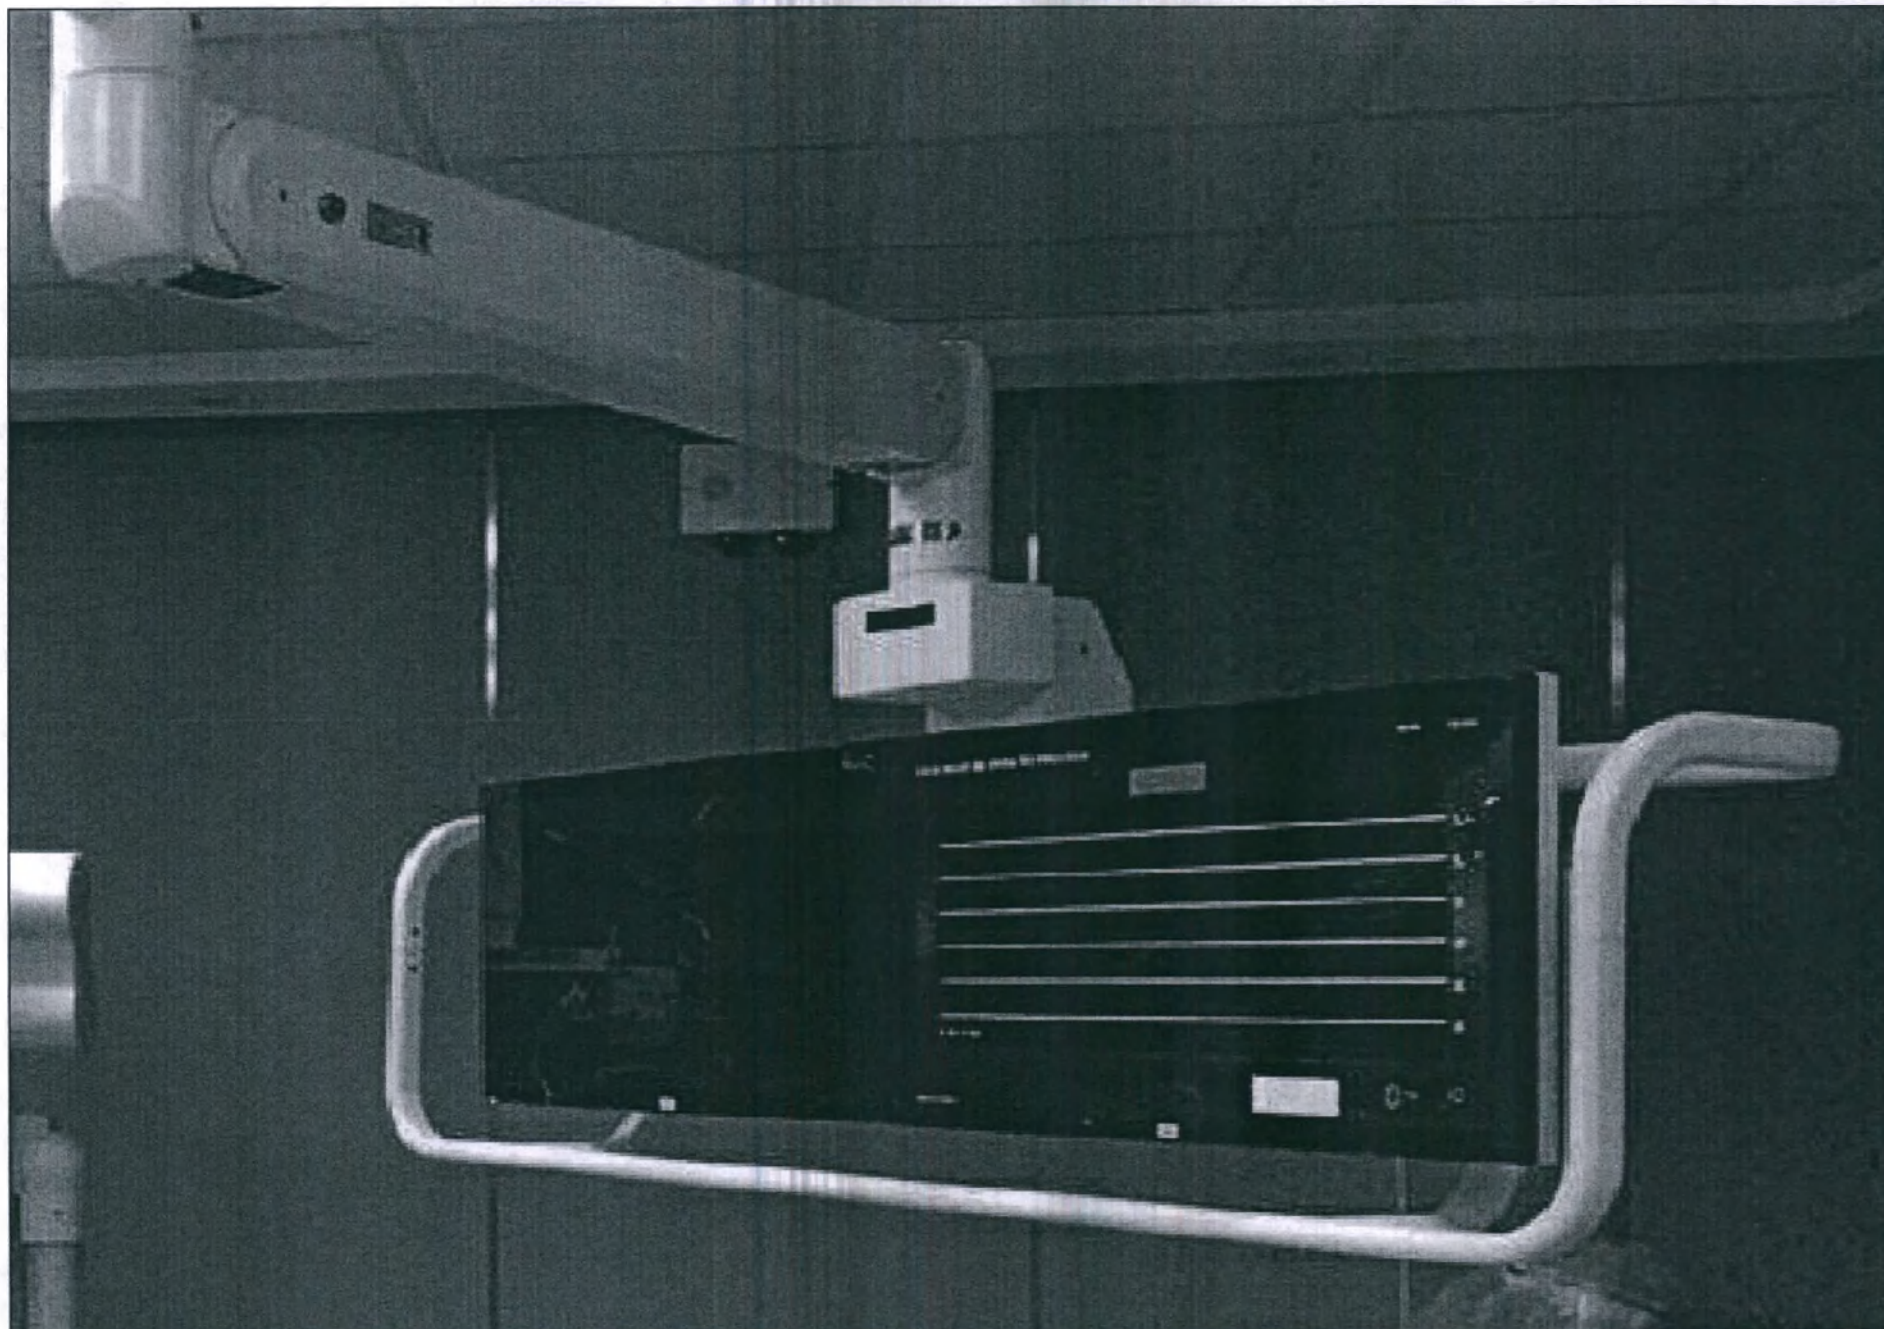


10. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

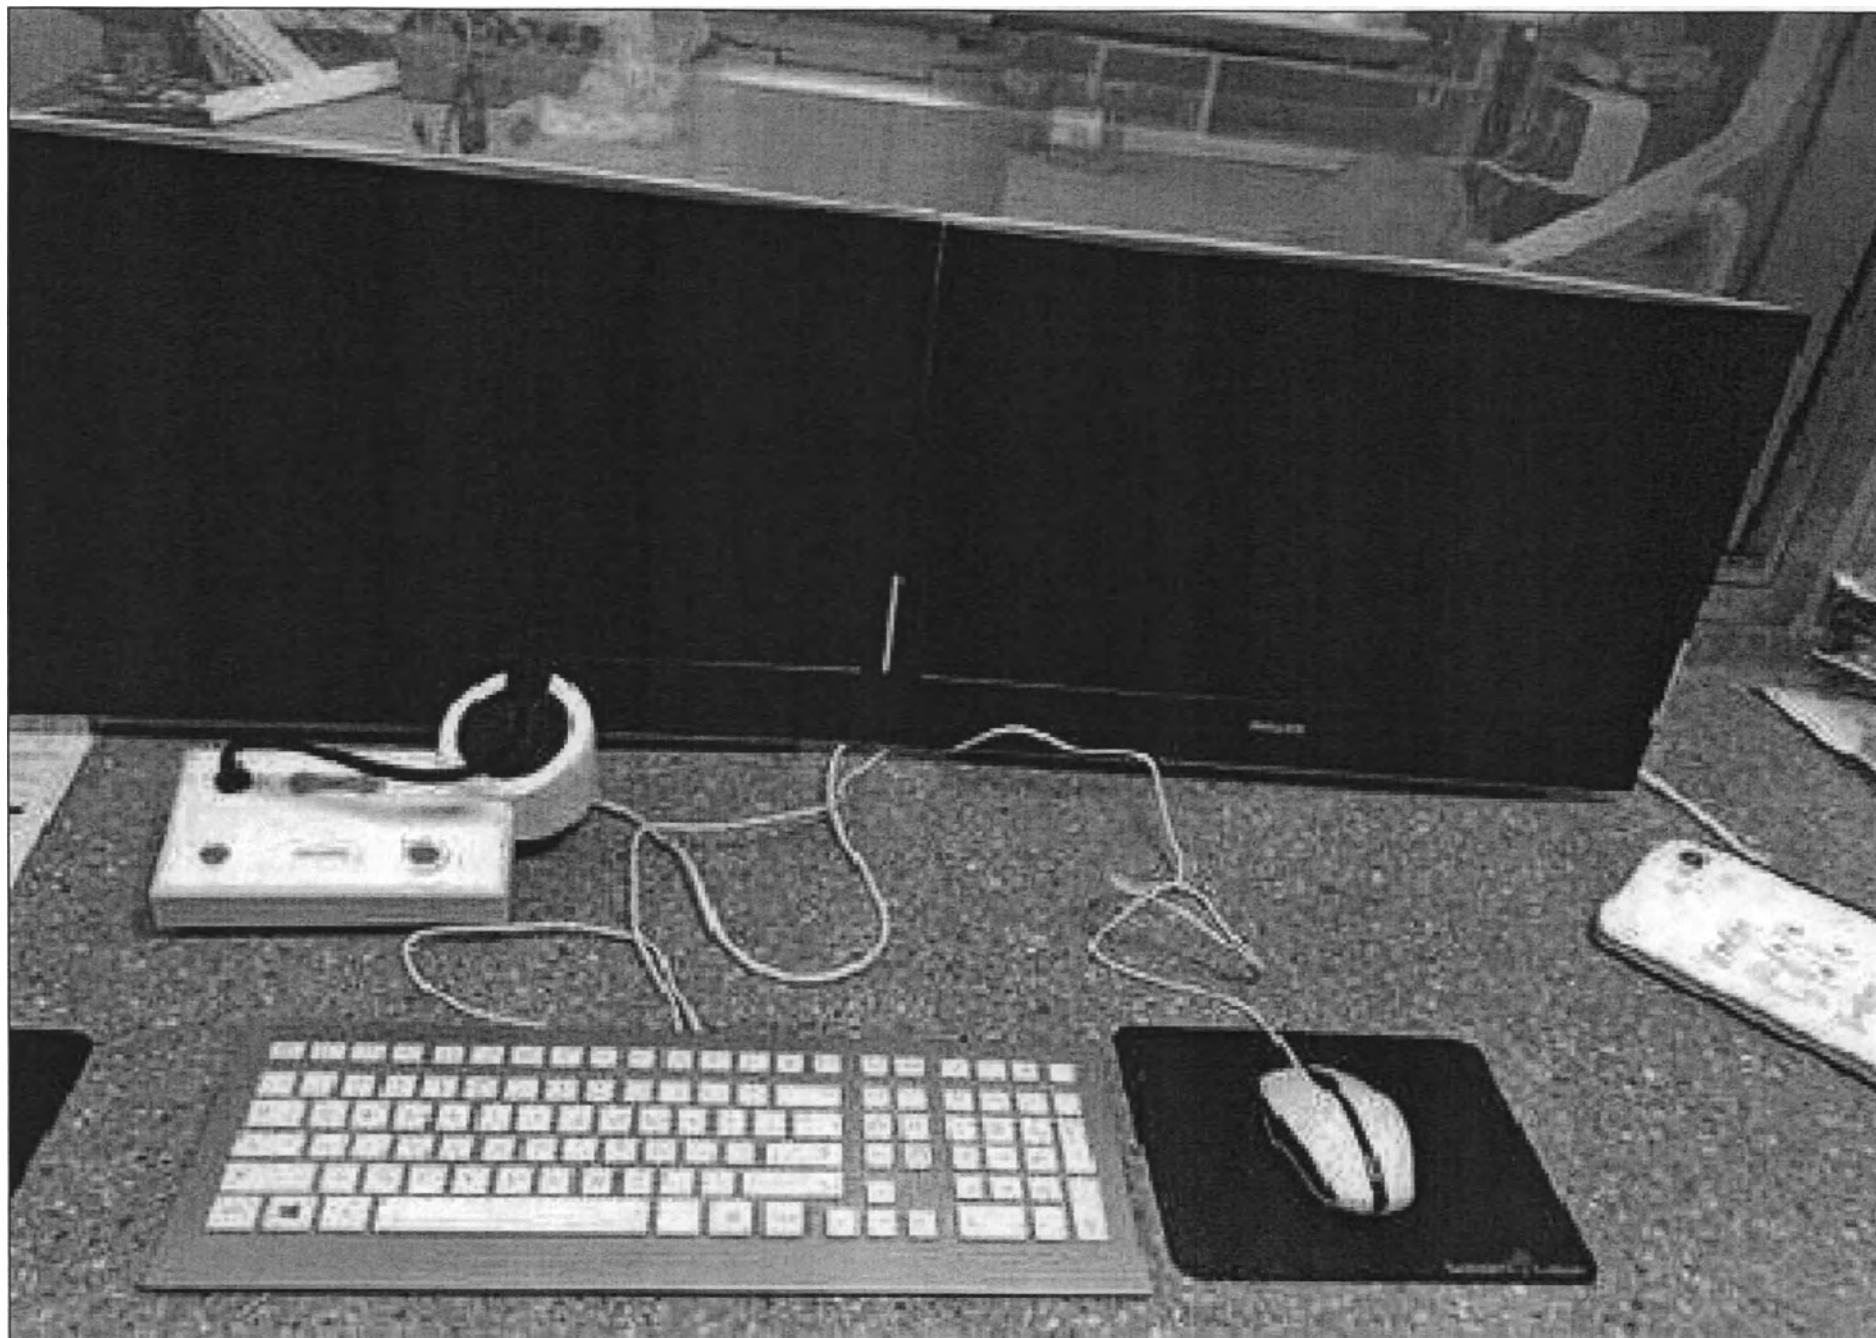


11.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.



11.6. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

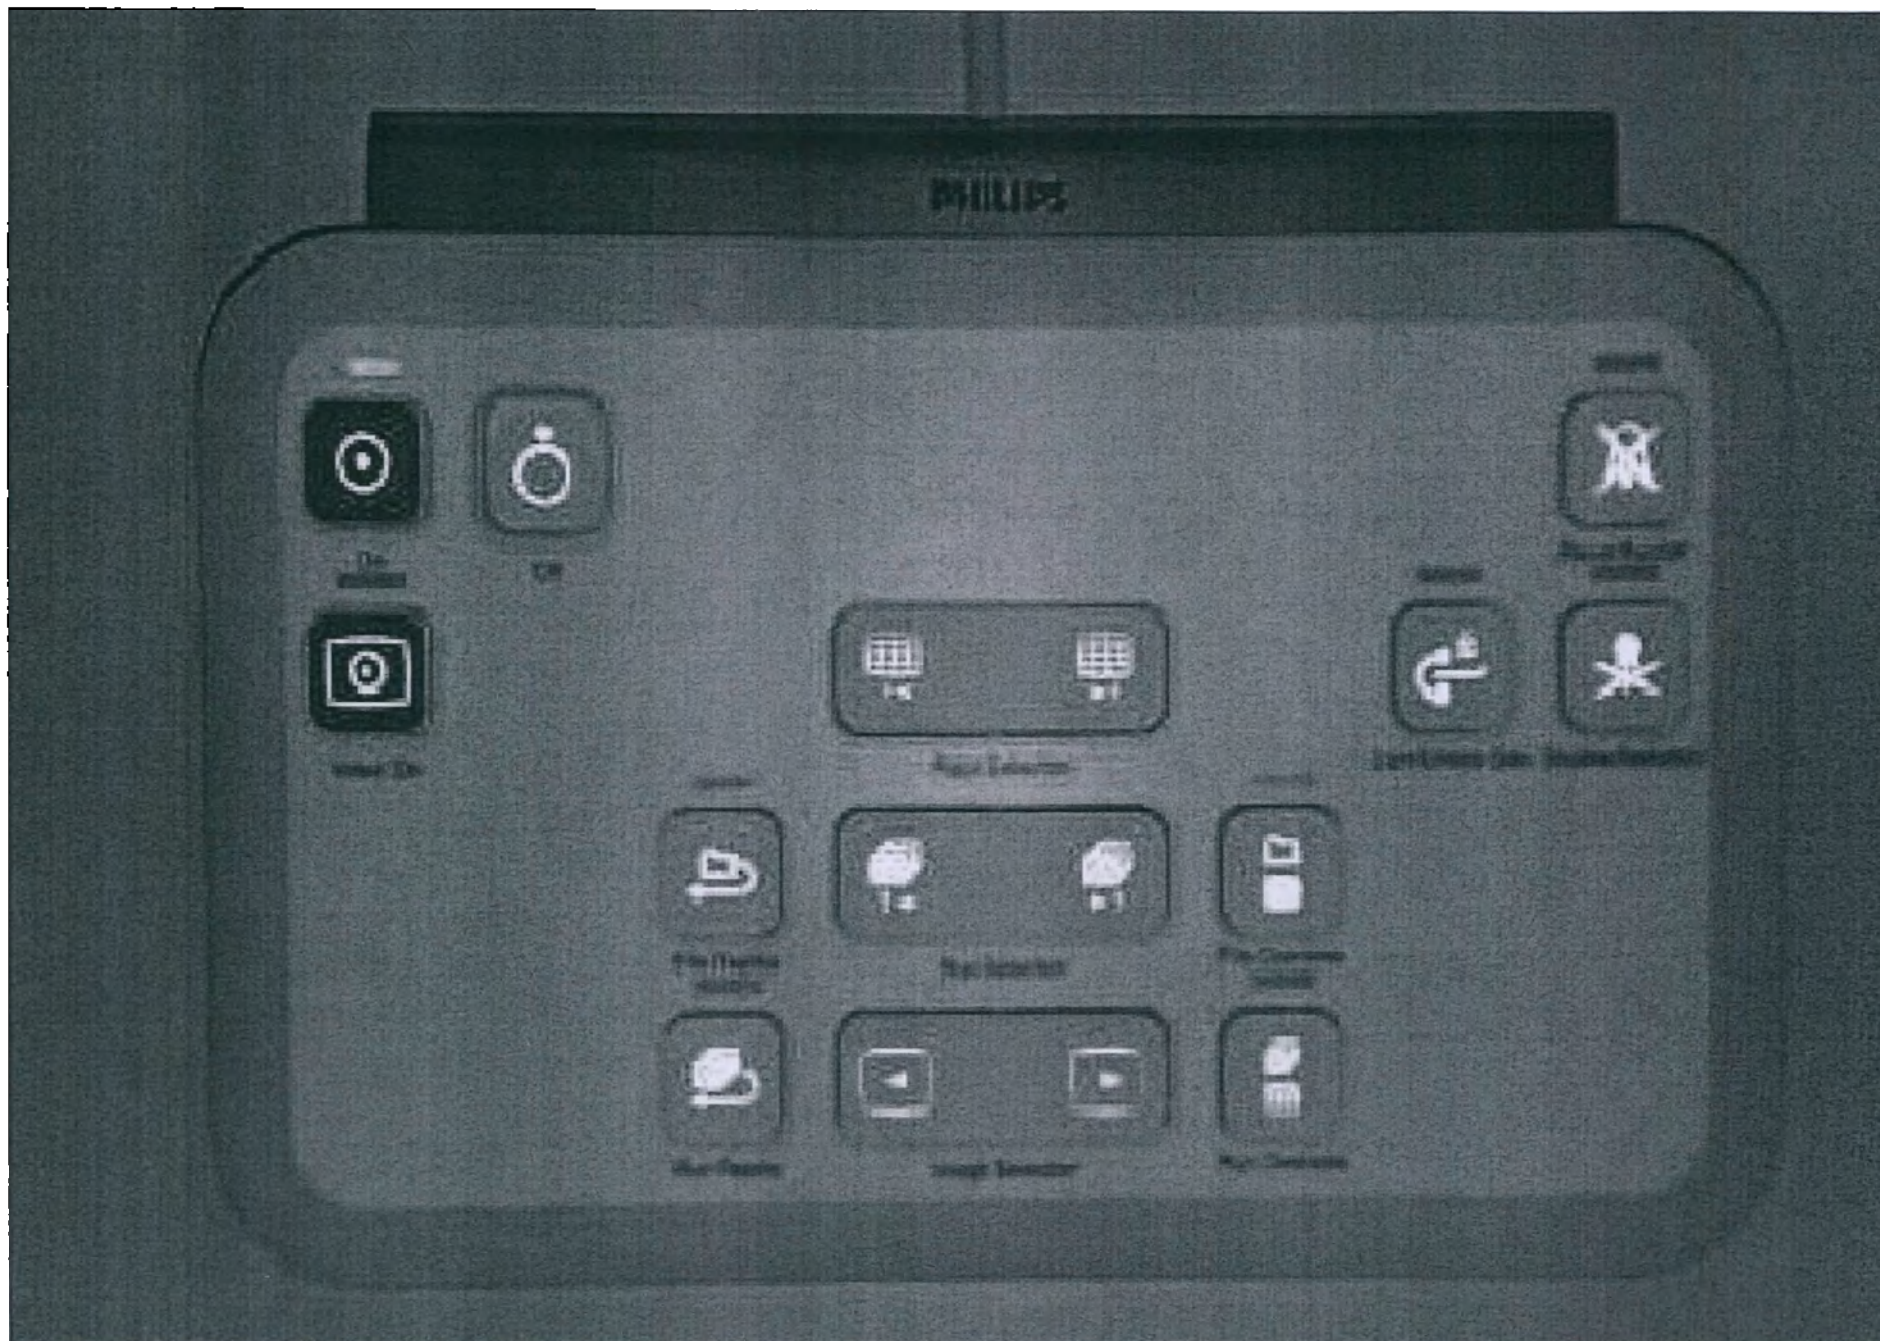


11.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; **Модуль просмотра**; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

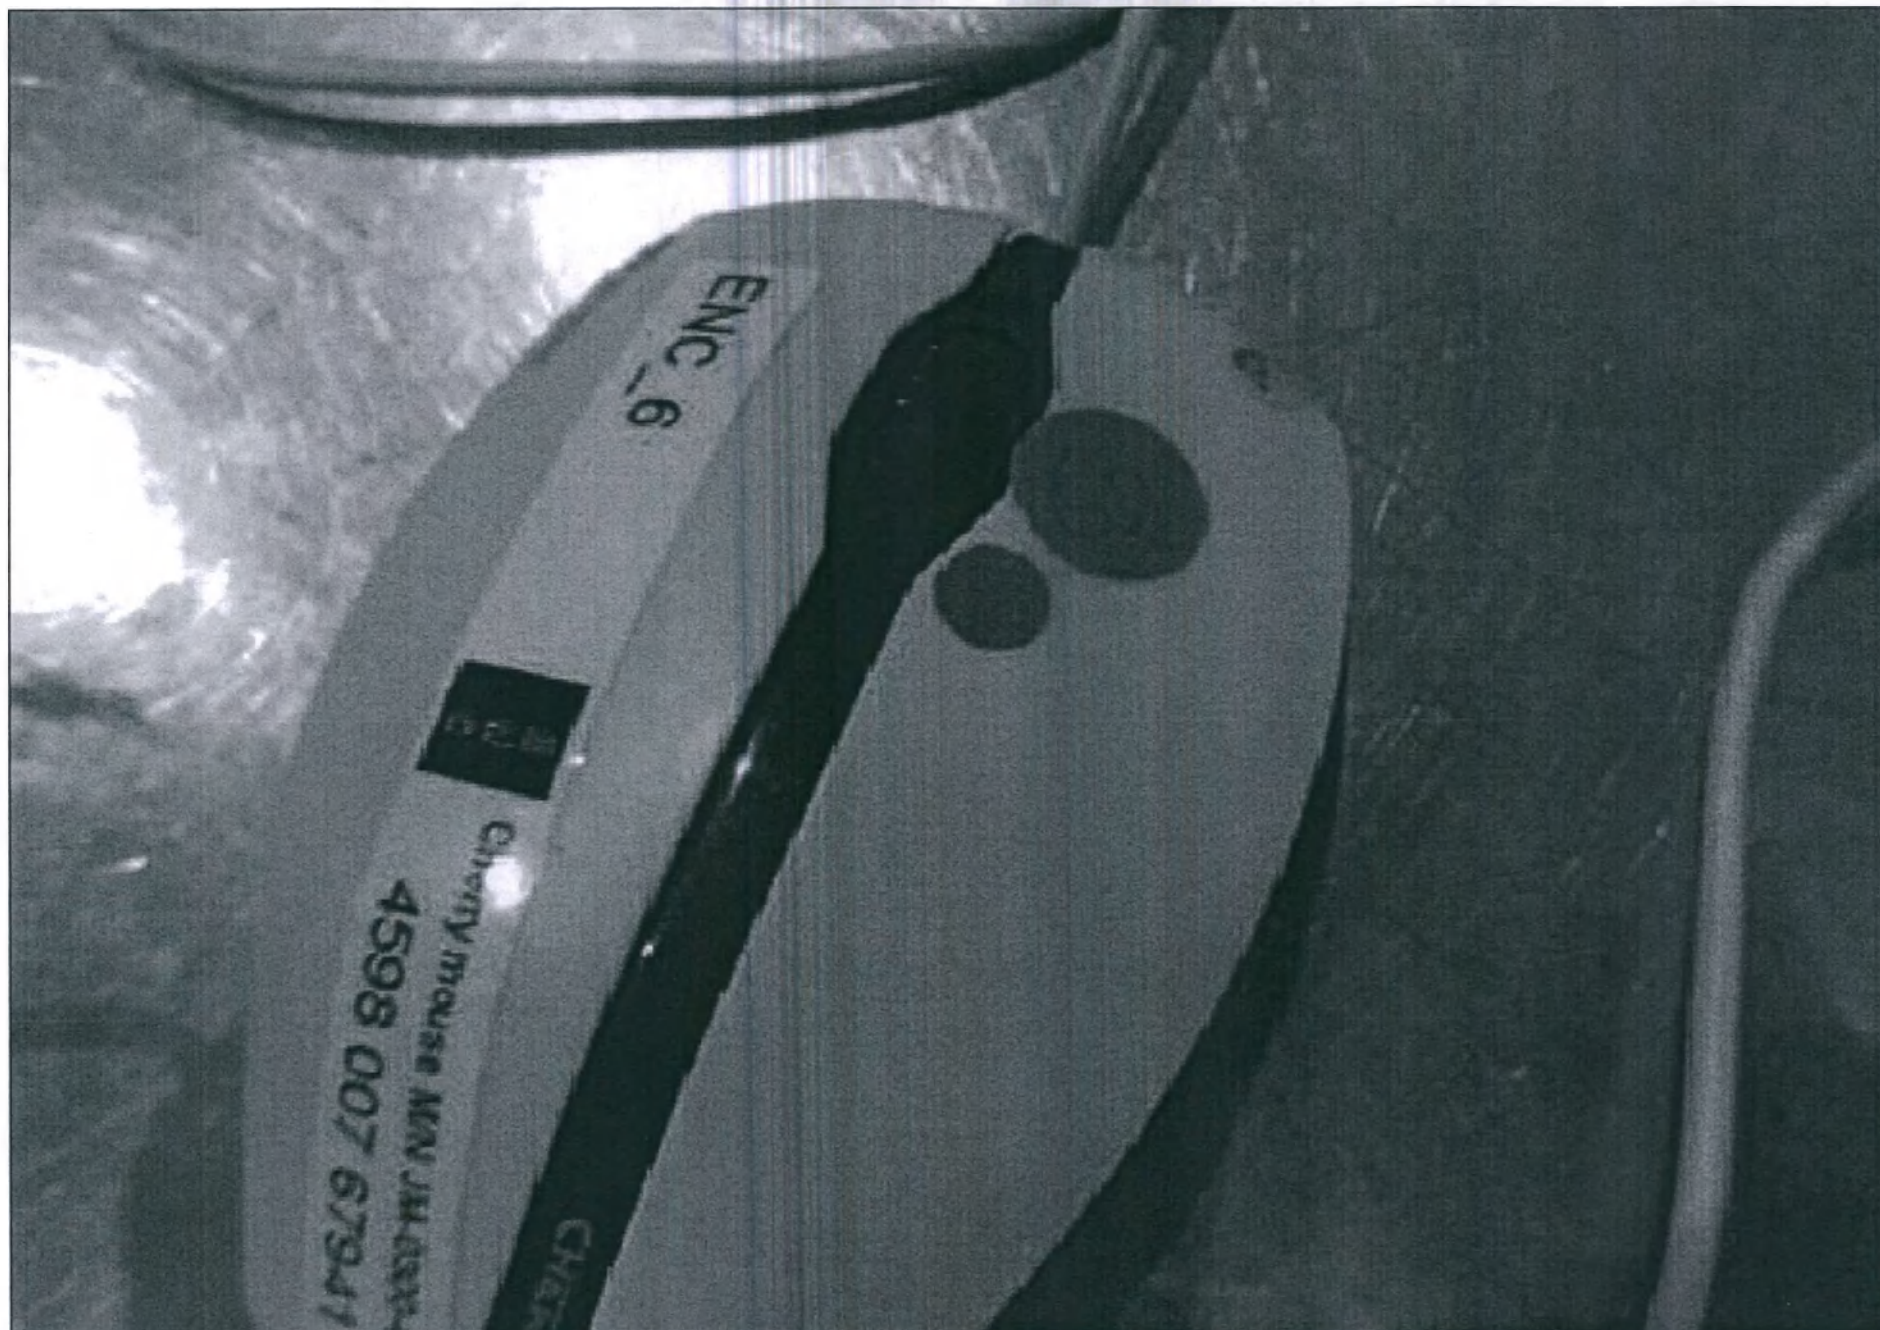


11.2. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; **Мышь**; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.




11.д. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

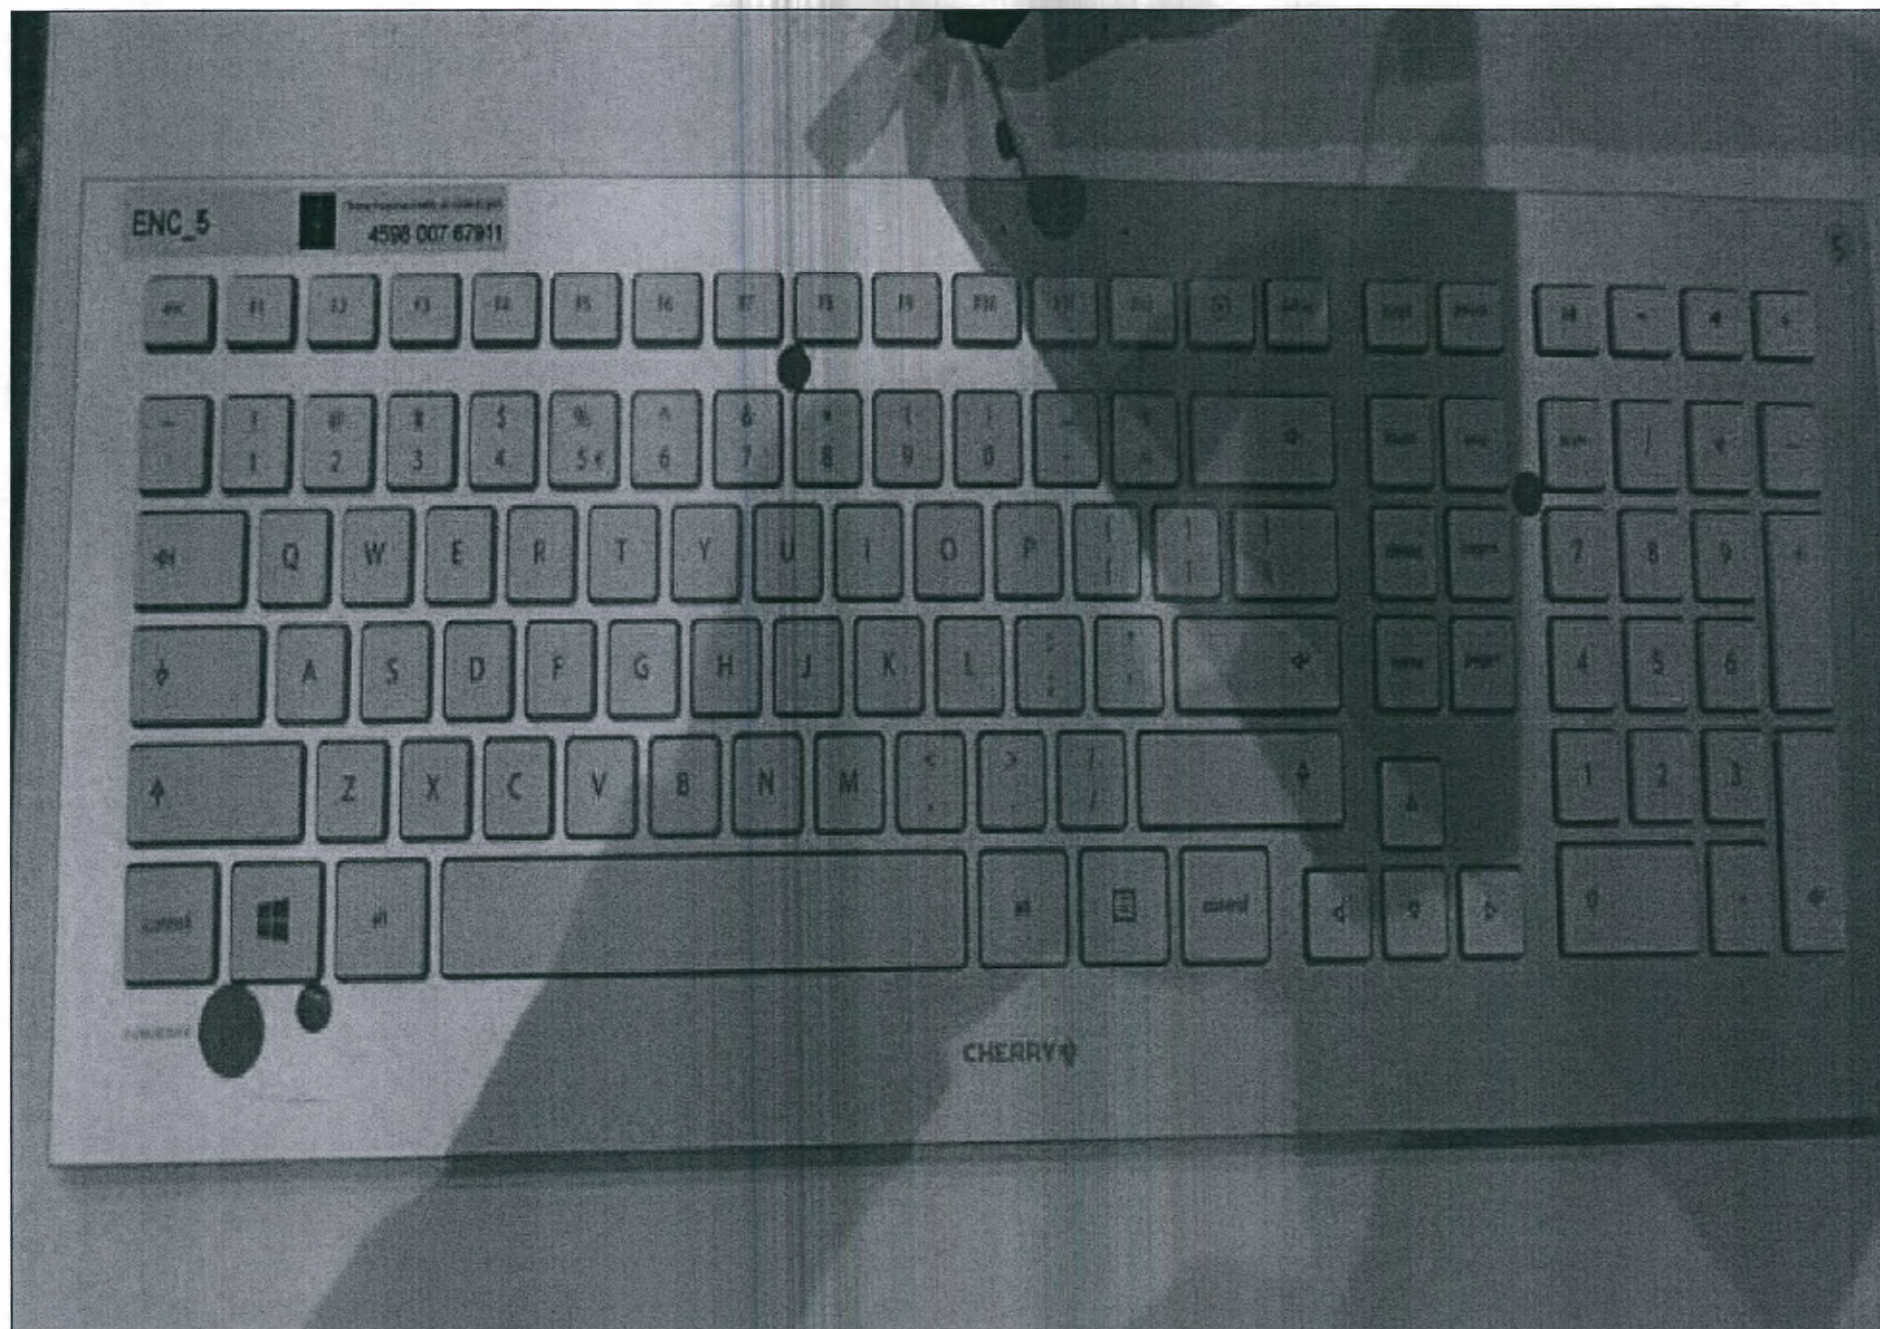


Ил.е. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

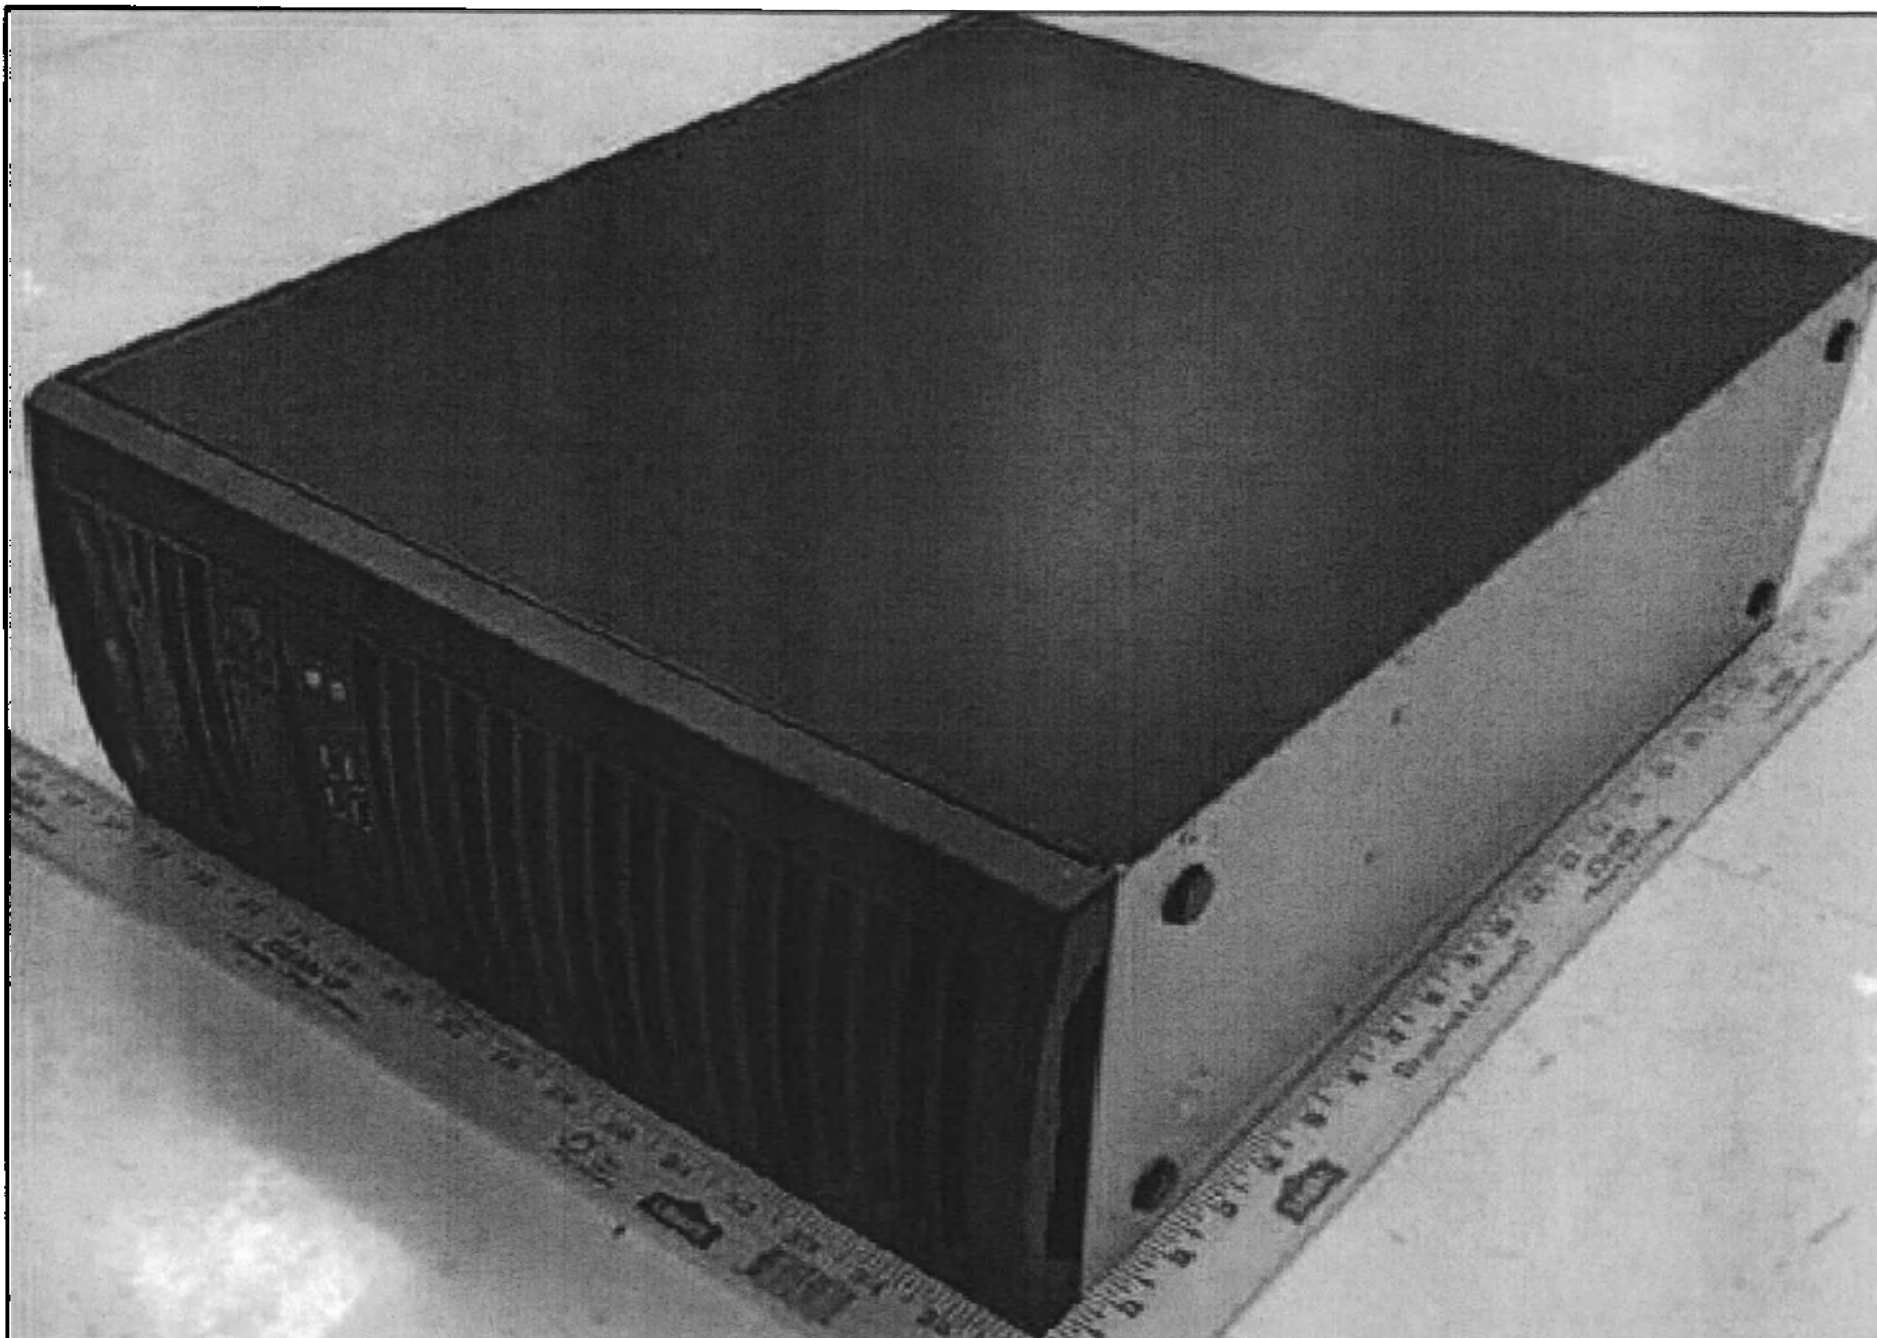


11.ж. Оборудование тультовой в составе: Мониторы цветные для тультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azirion версия 1.2 и выше.

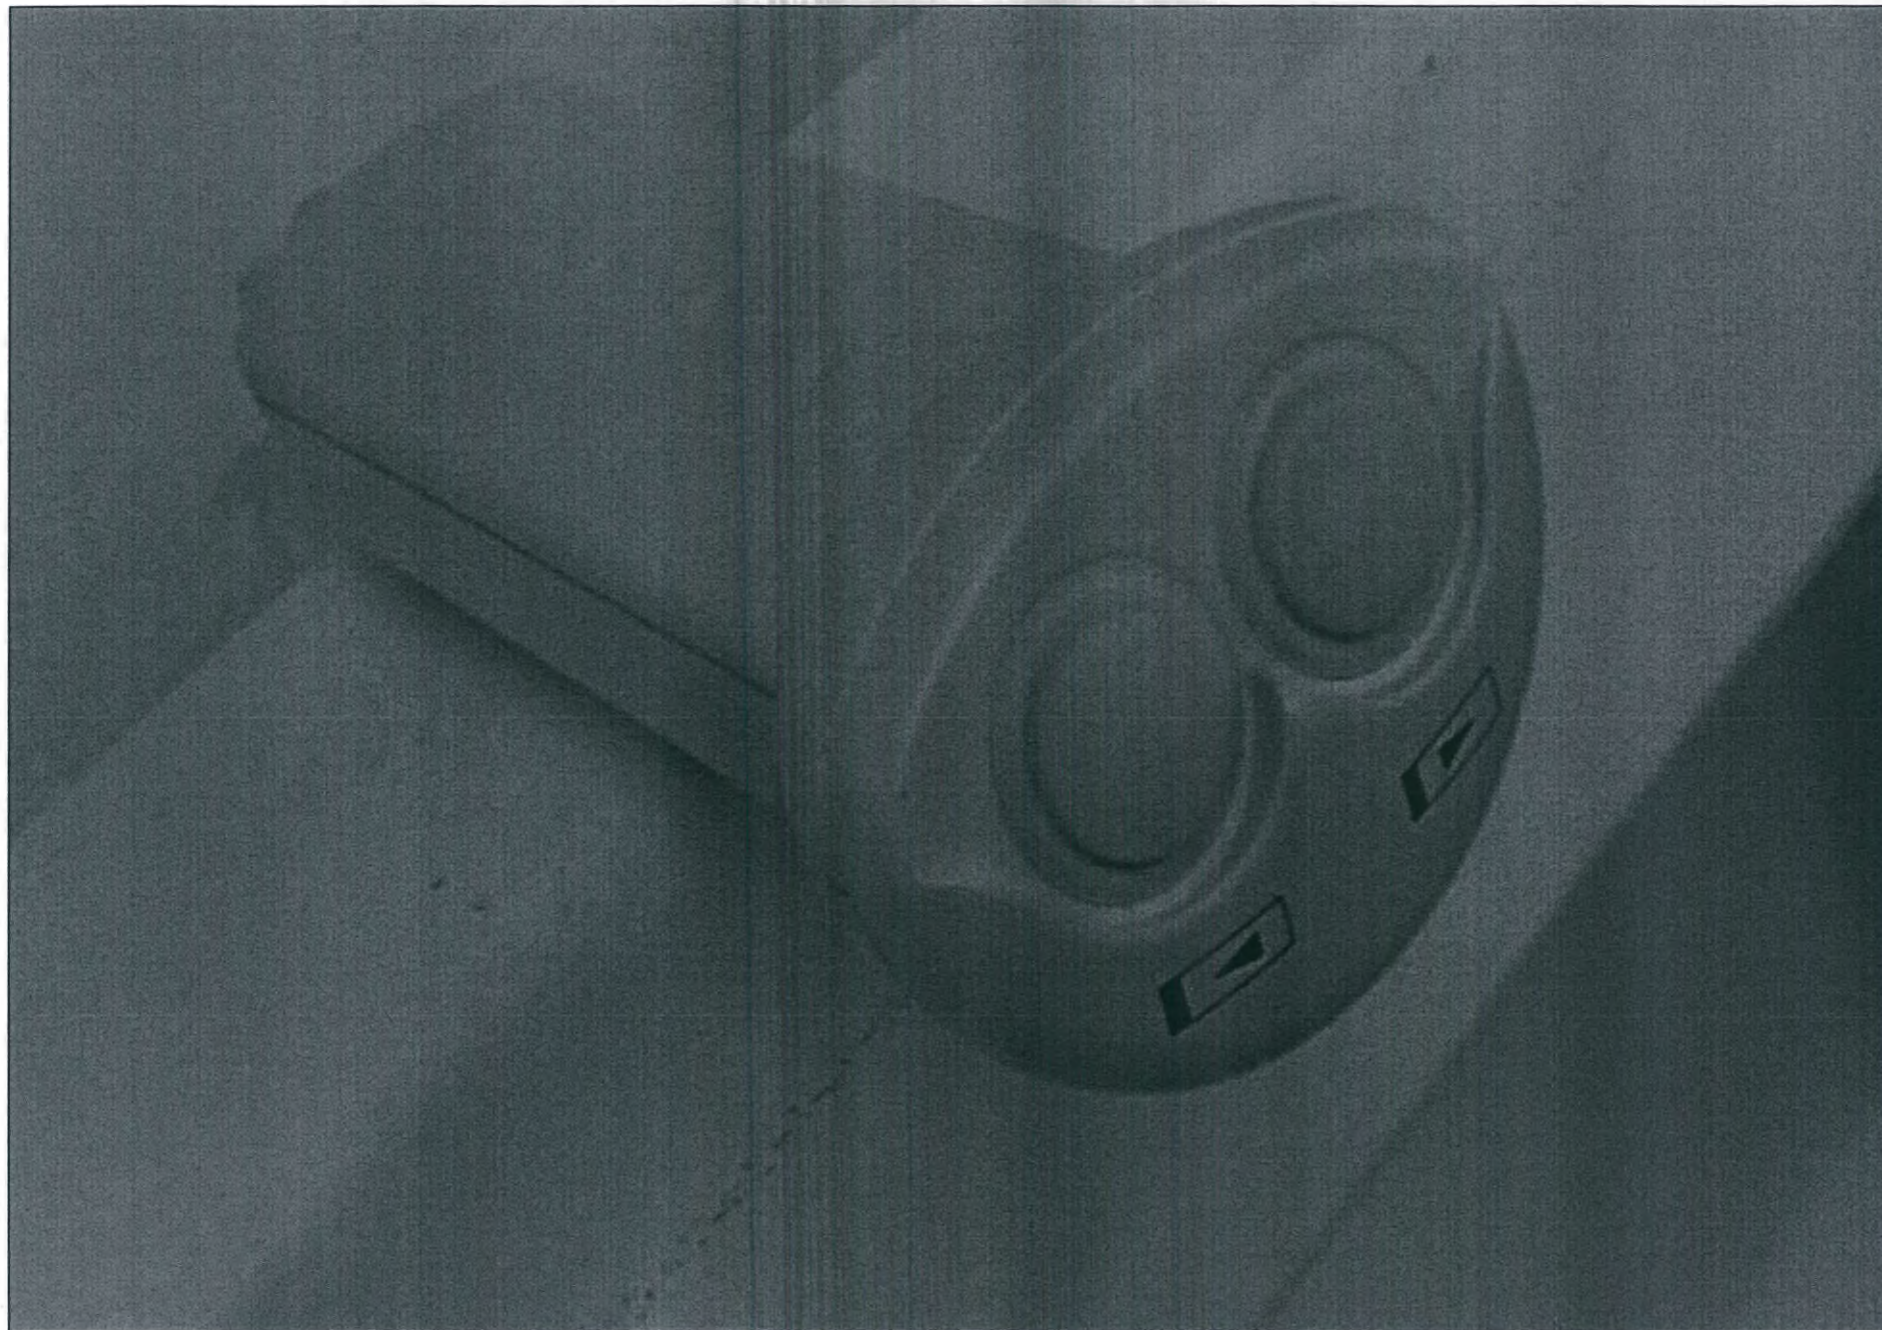


12. Ручной переключатель сдвига.

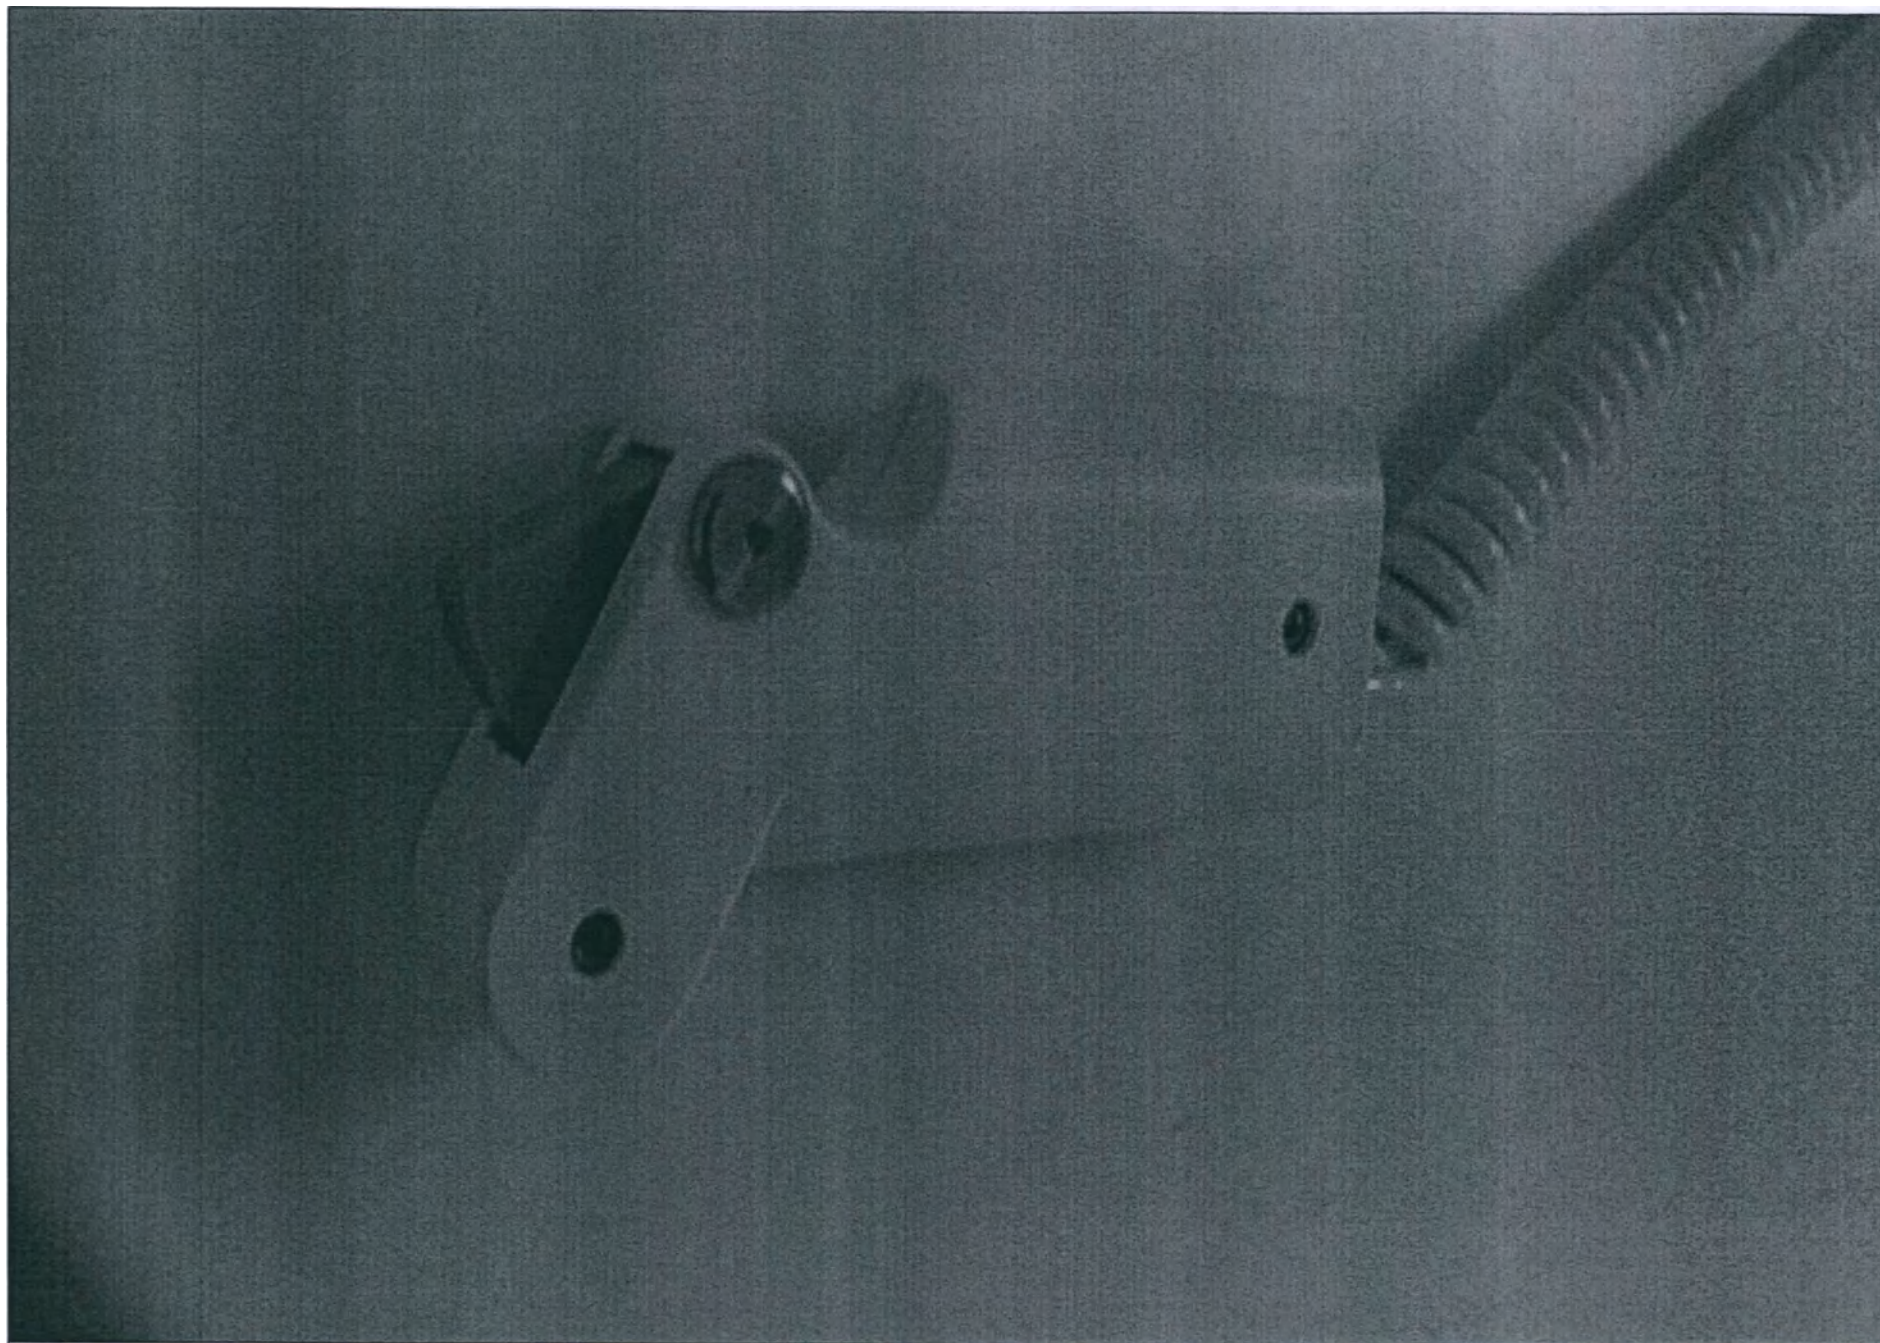


13. Регулятор скорости.

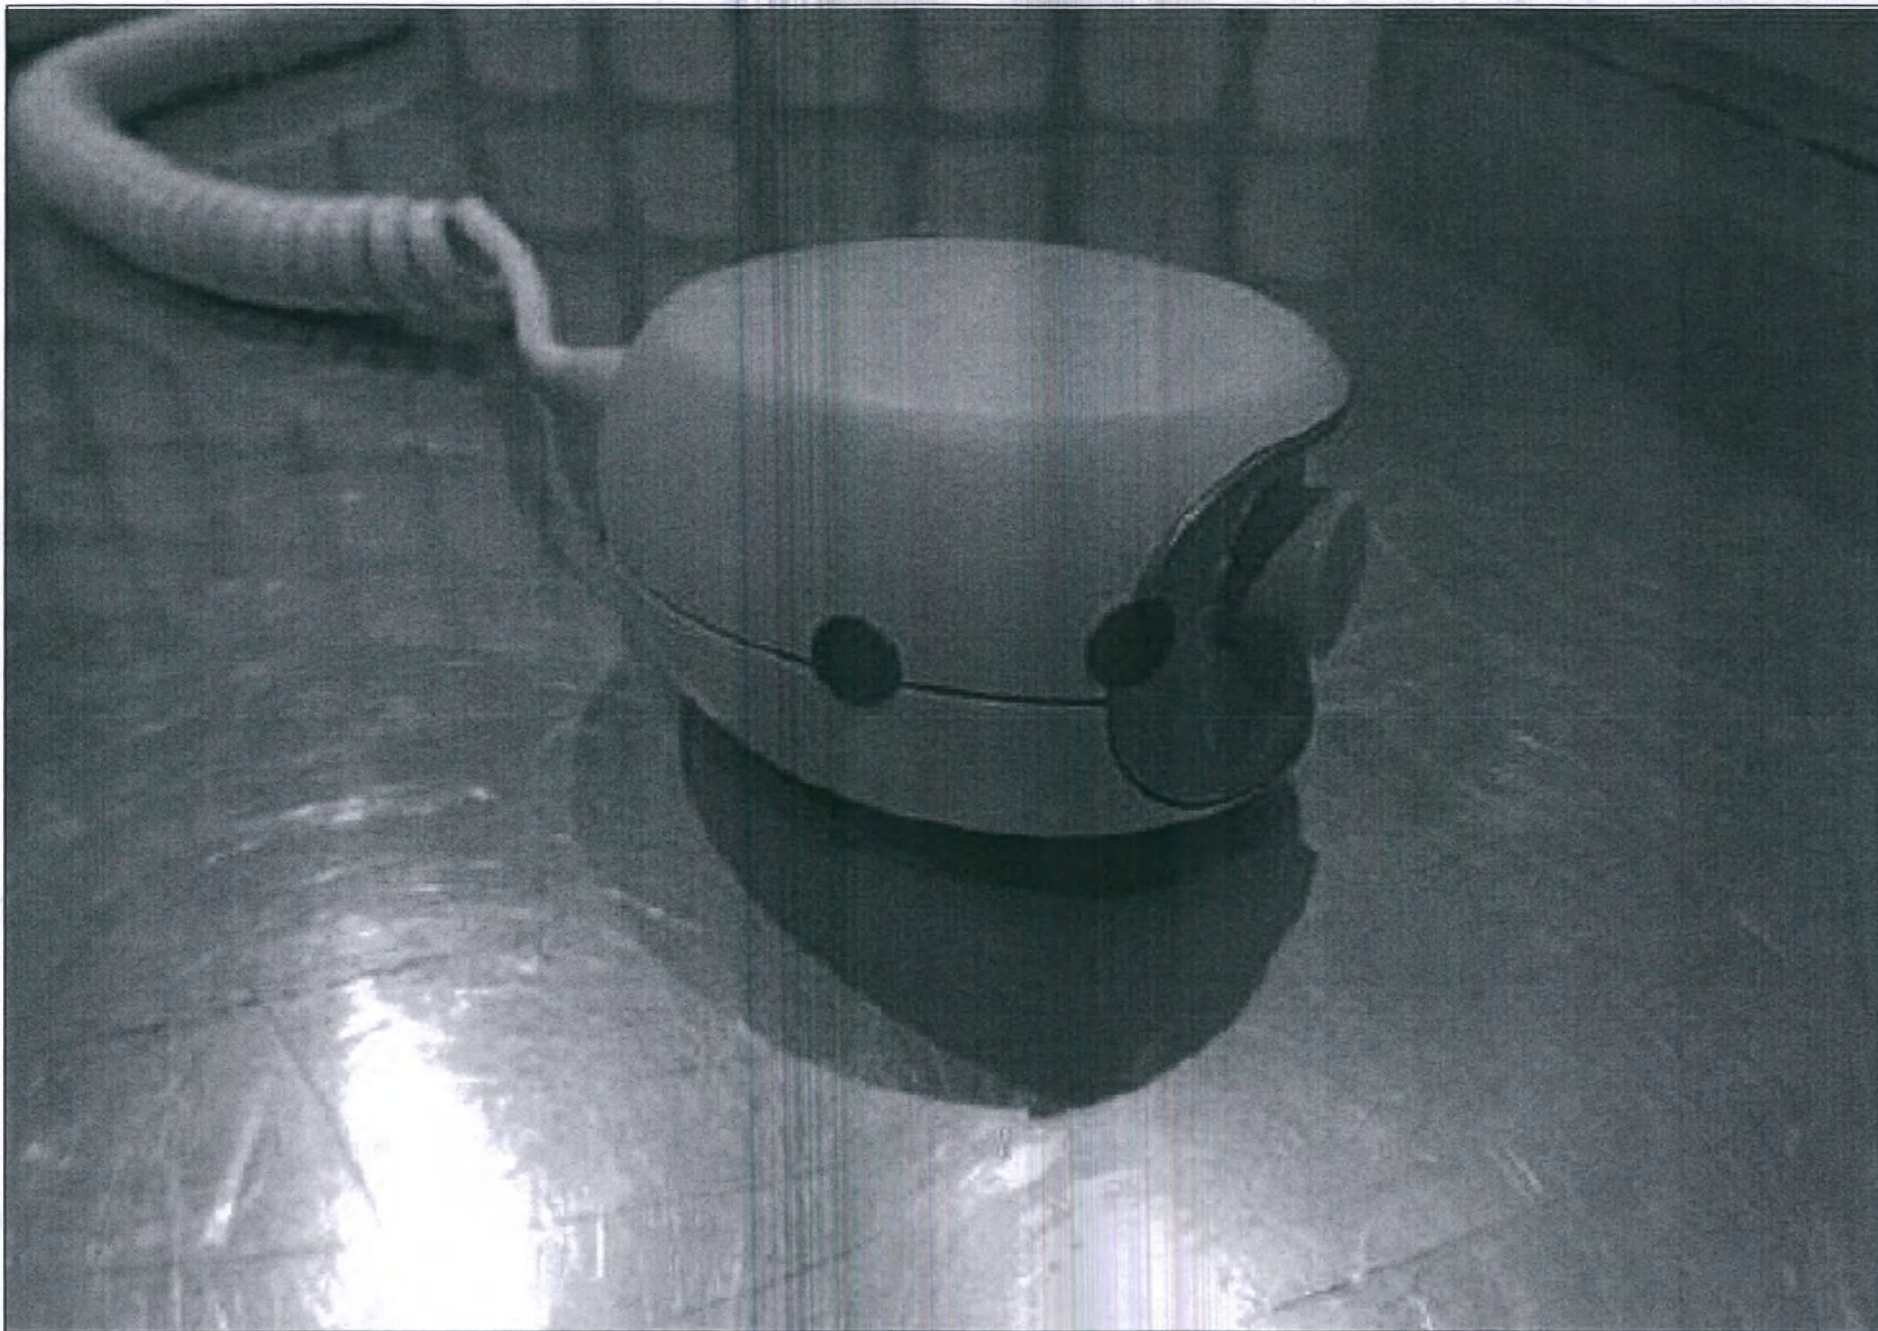


14. Ручной переключатель экспозиции.

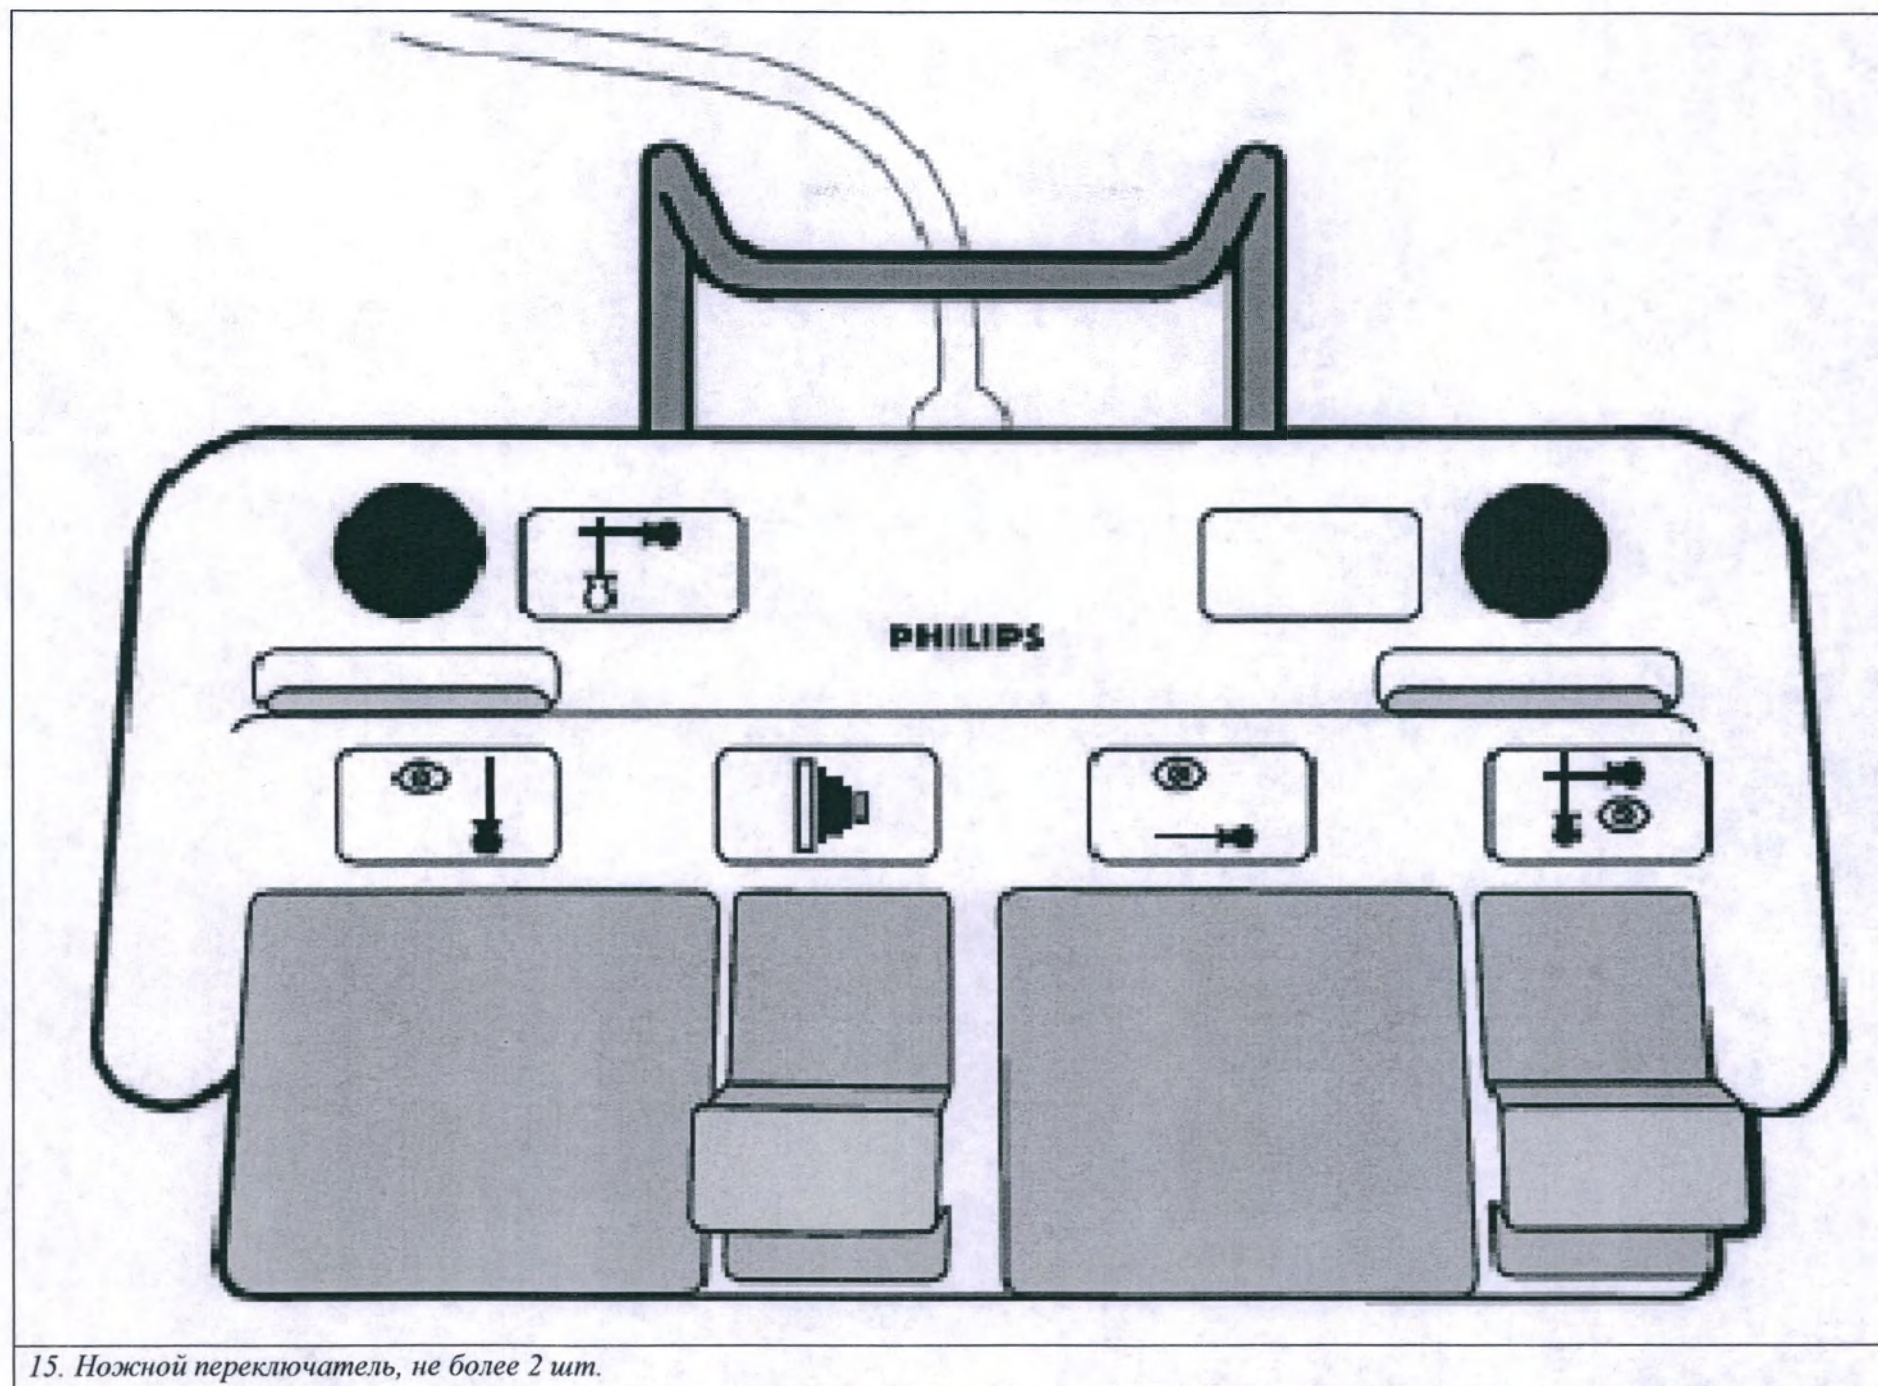


15. Ножной переключатель, не более 2 шт.

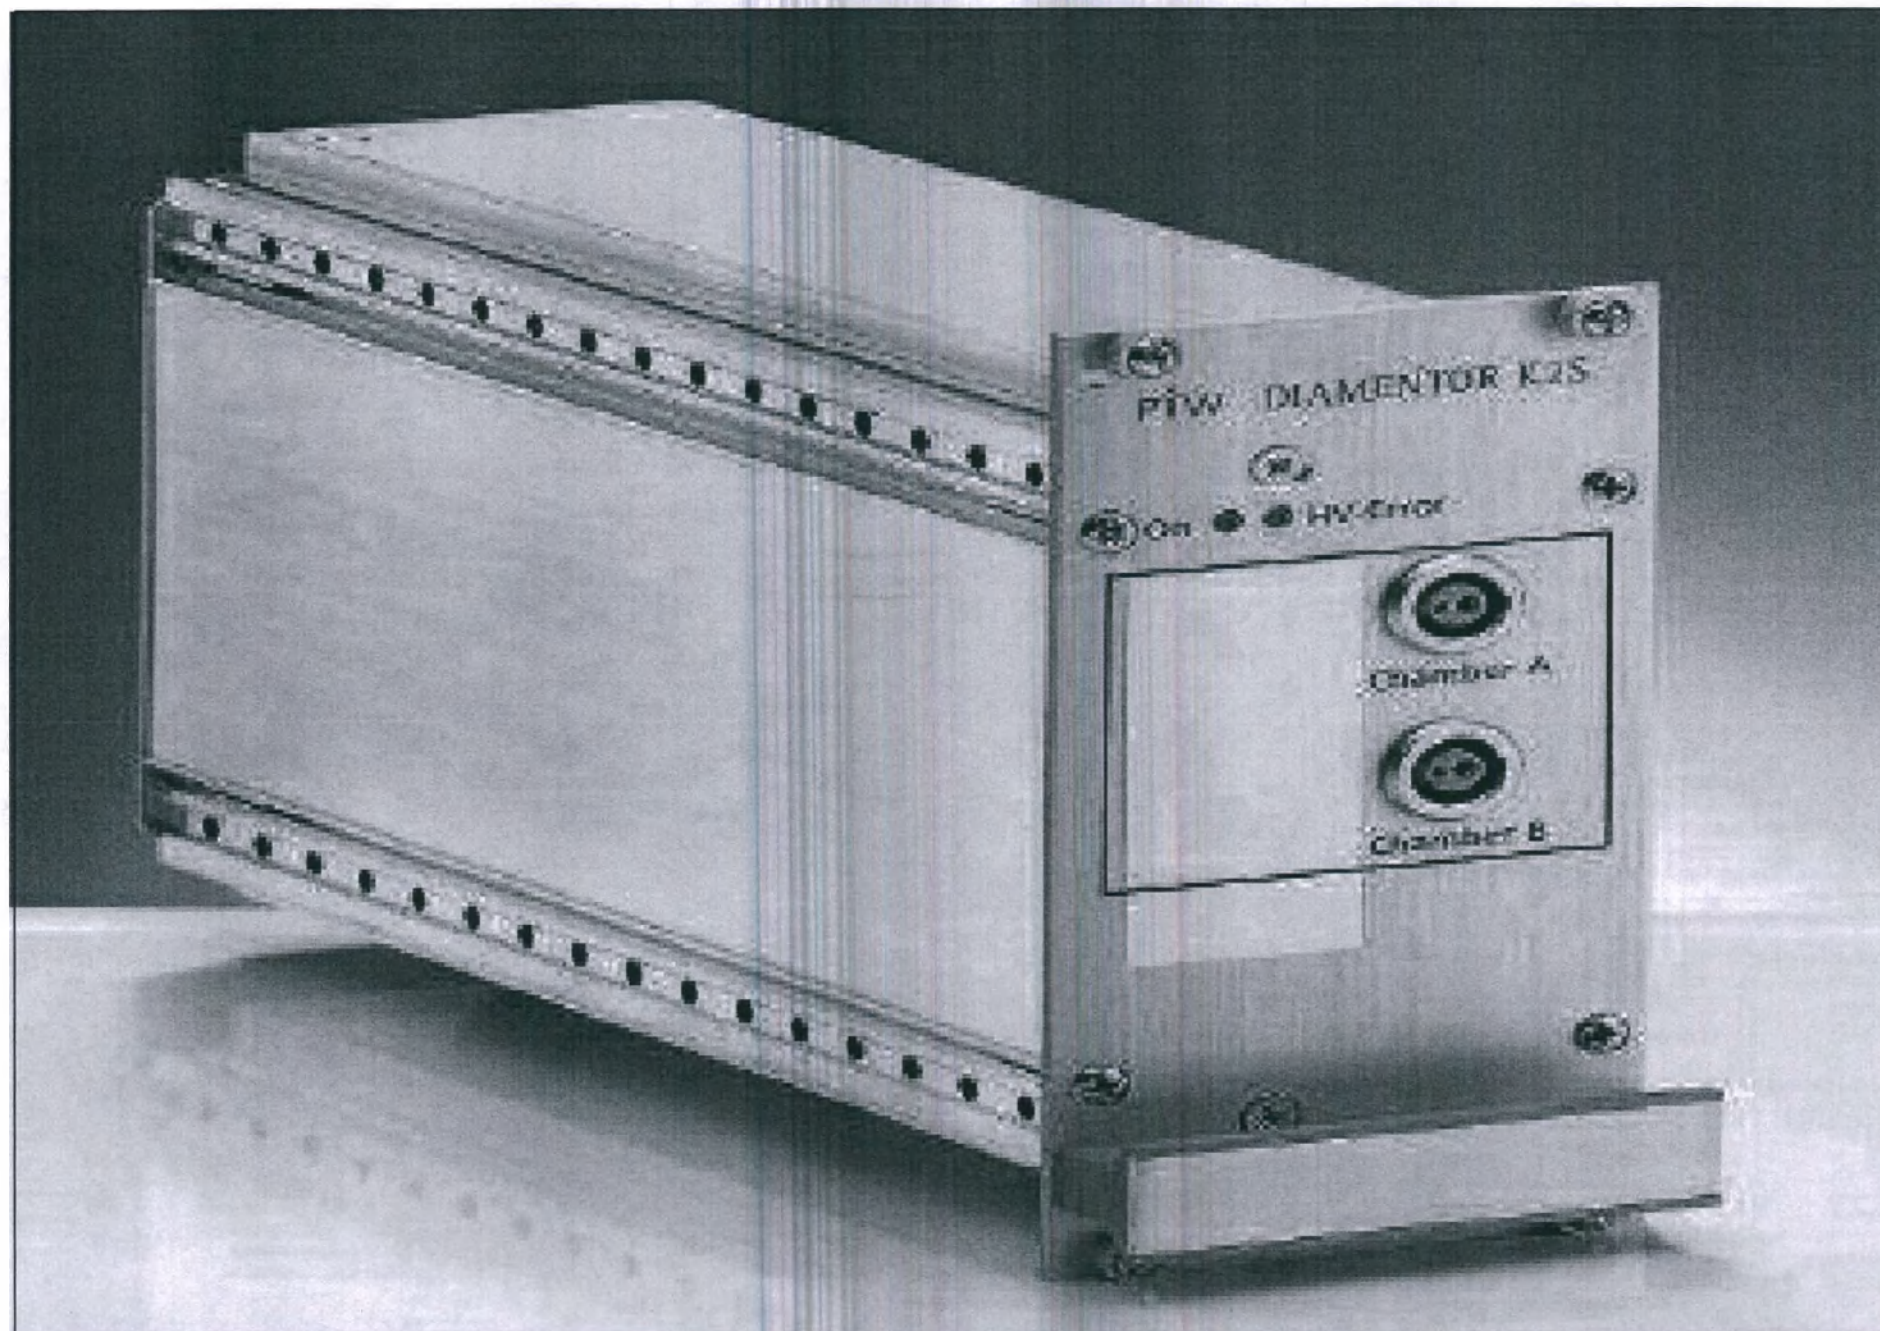


16.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

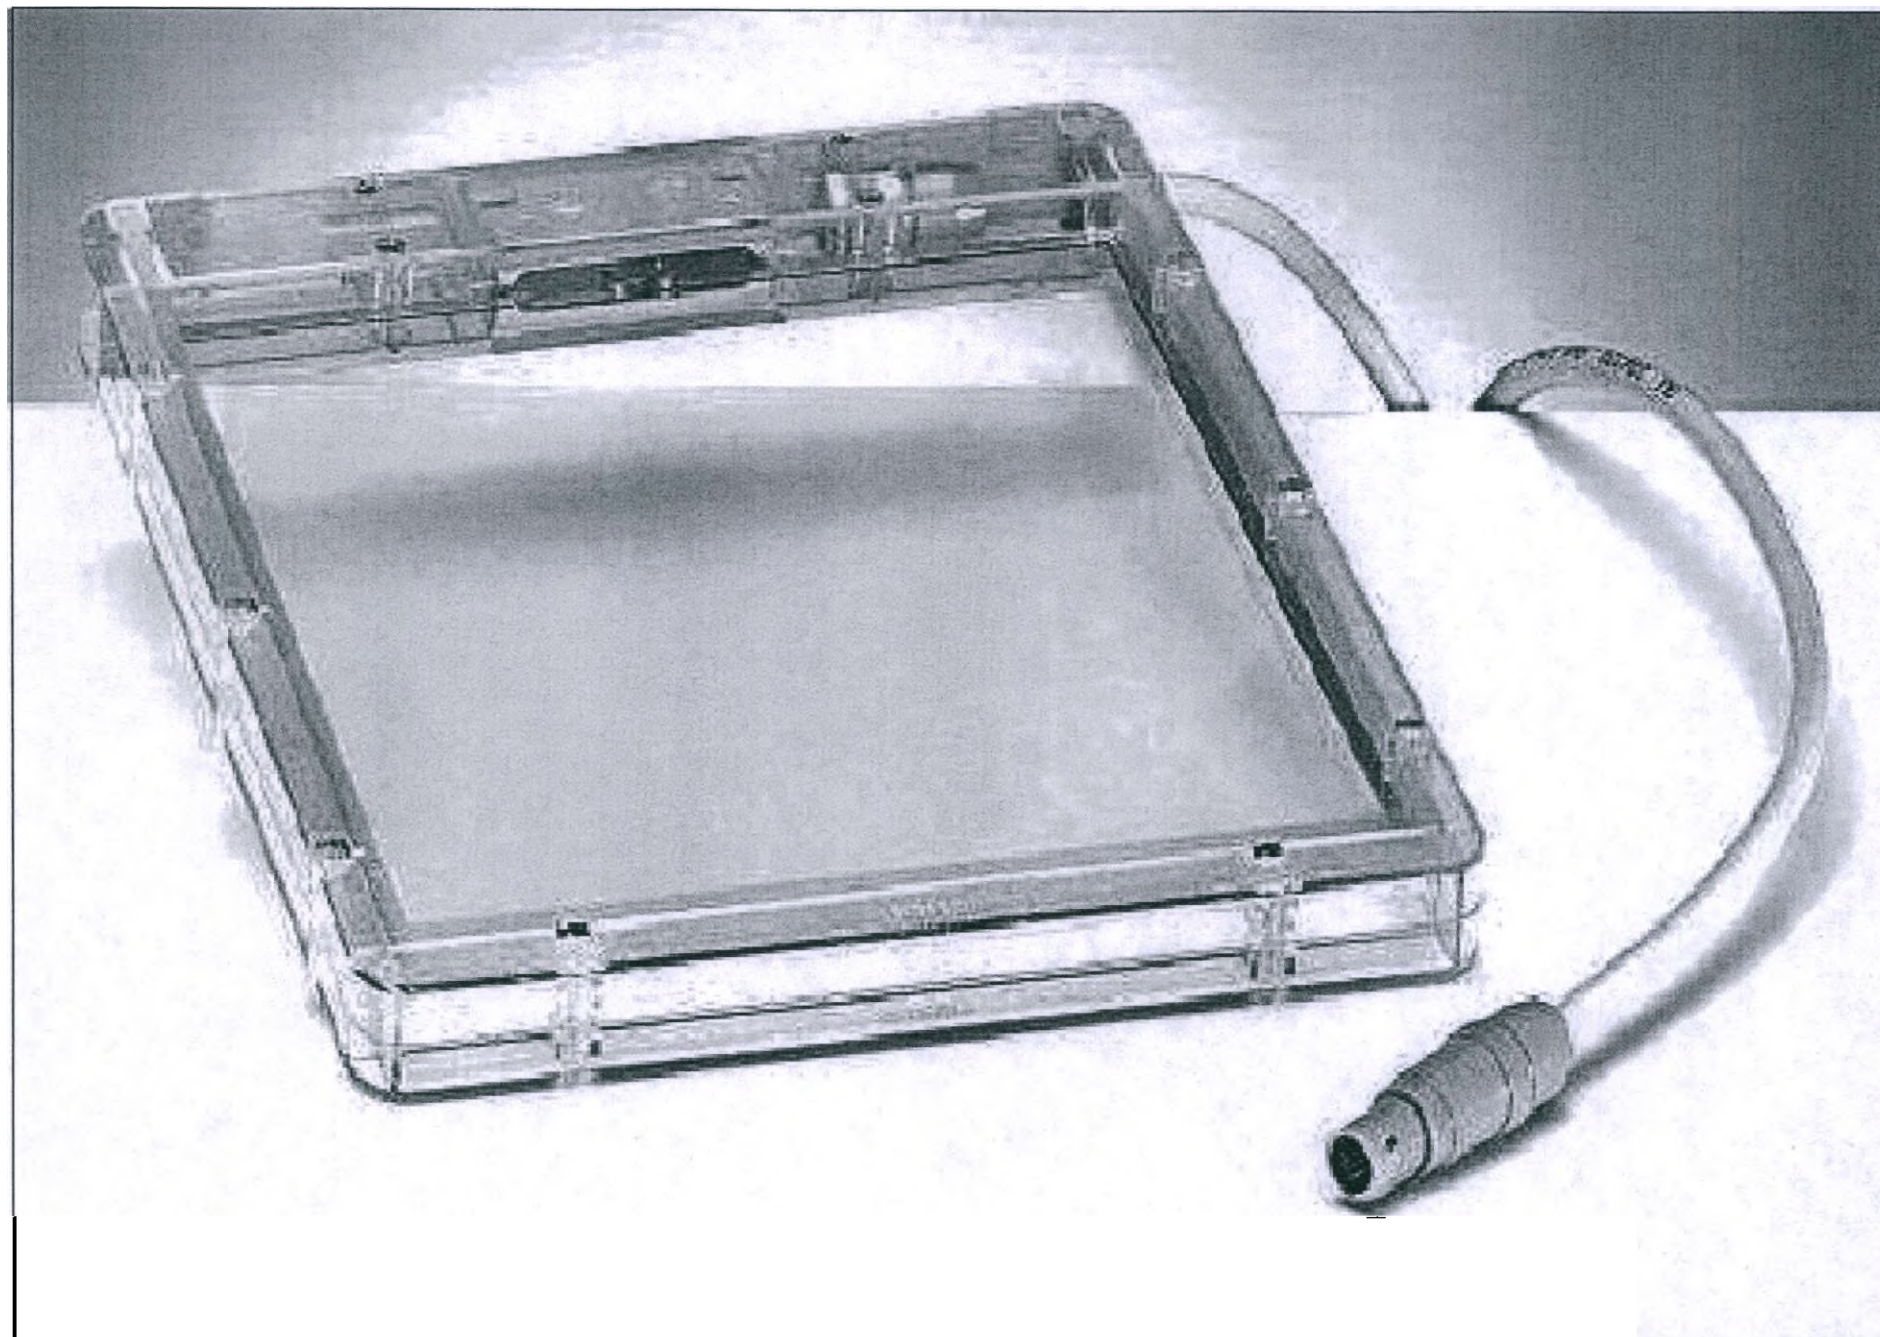


16.6. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДРК-1* или *ДРК-1М*.

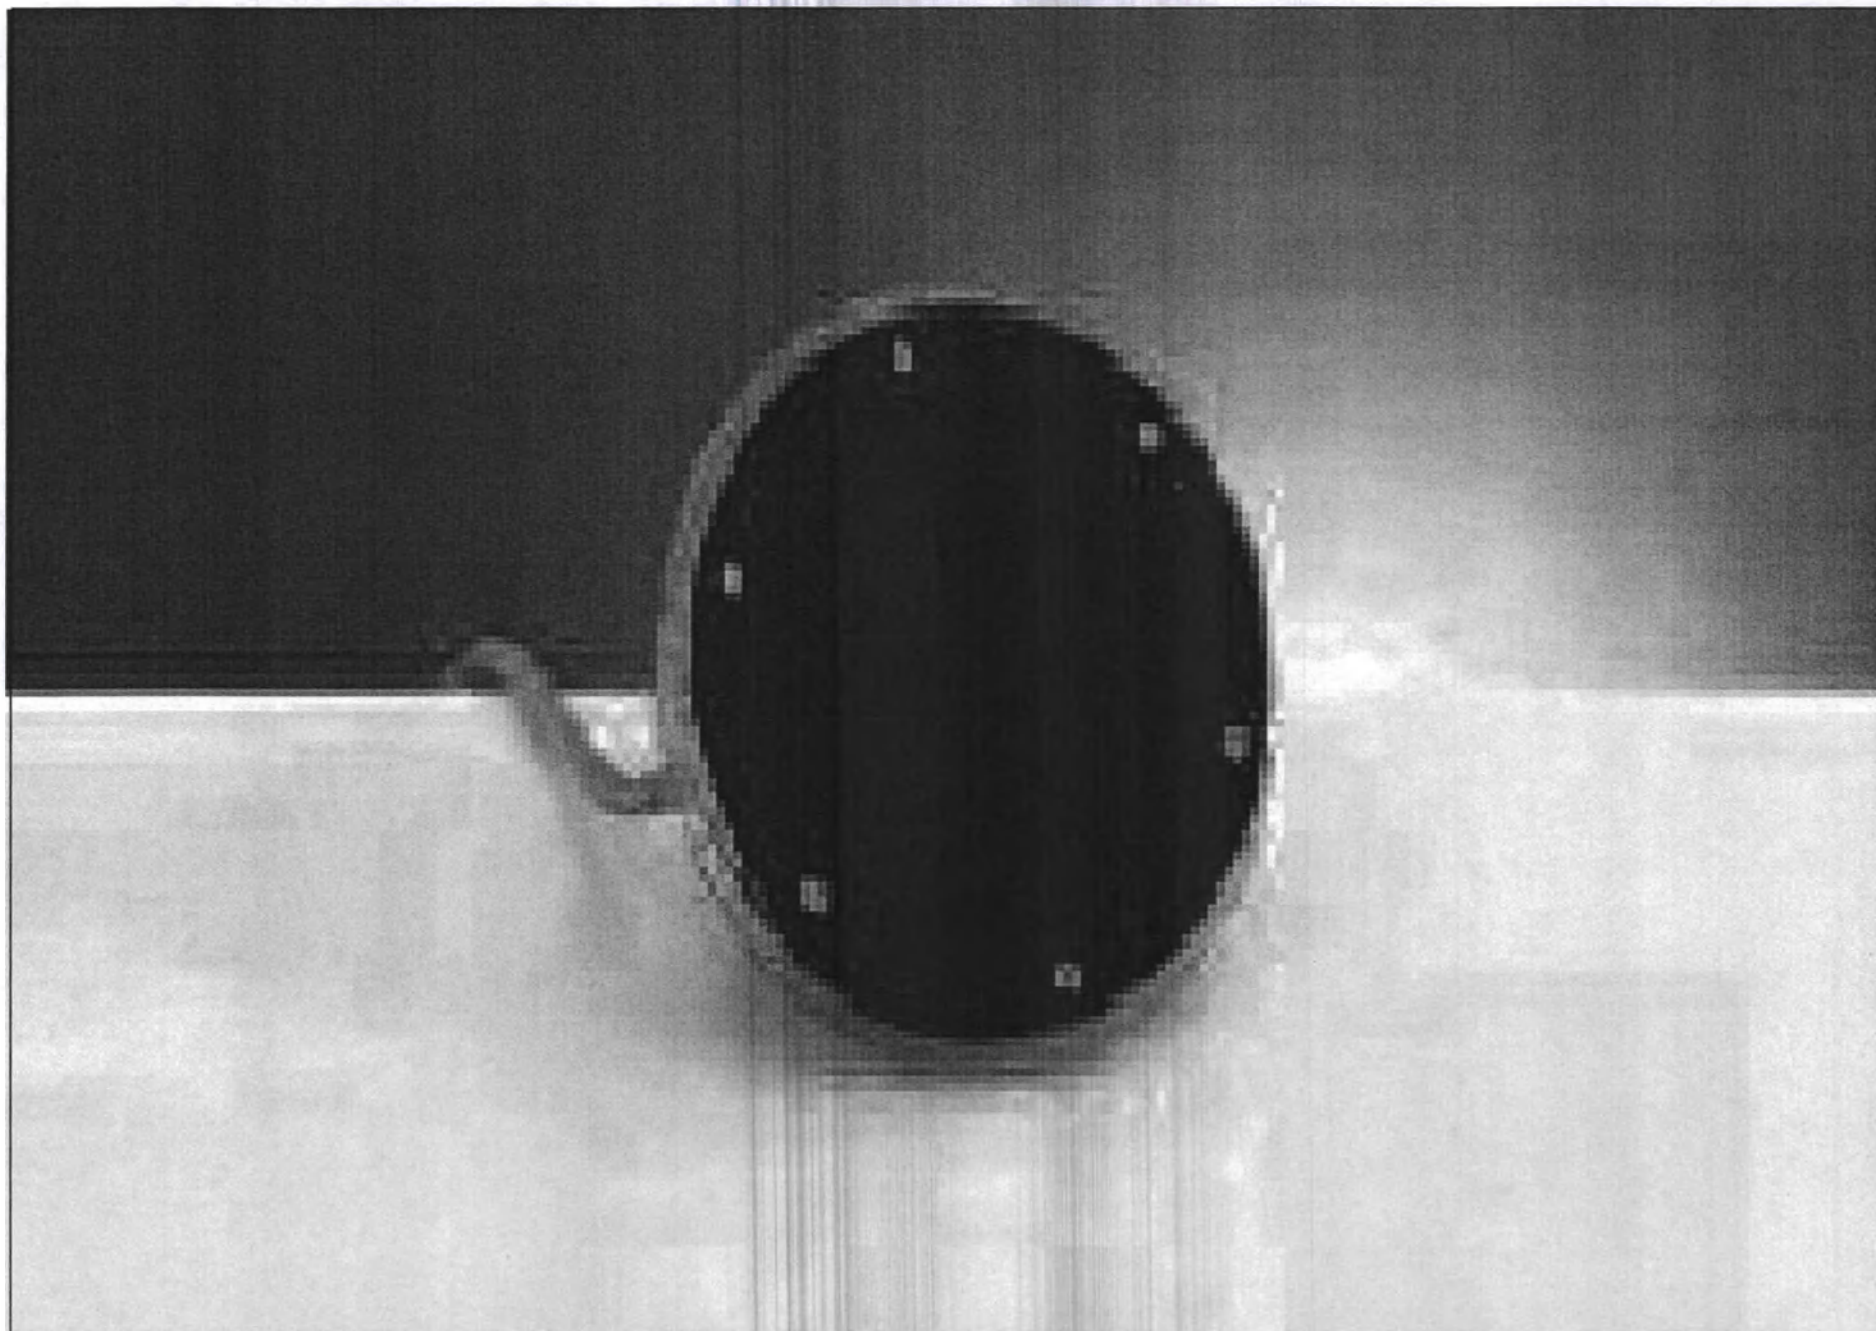


16.в. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

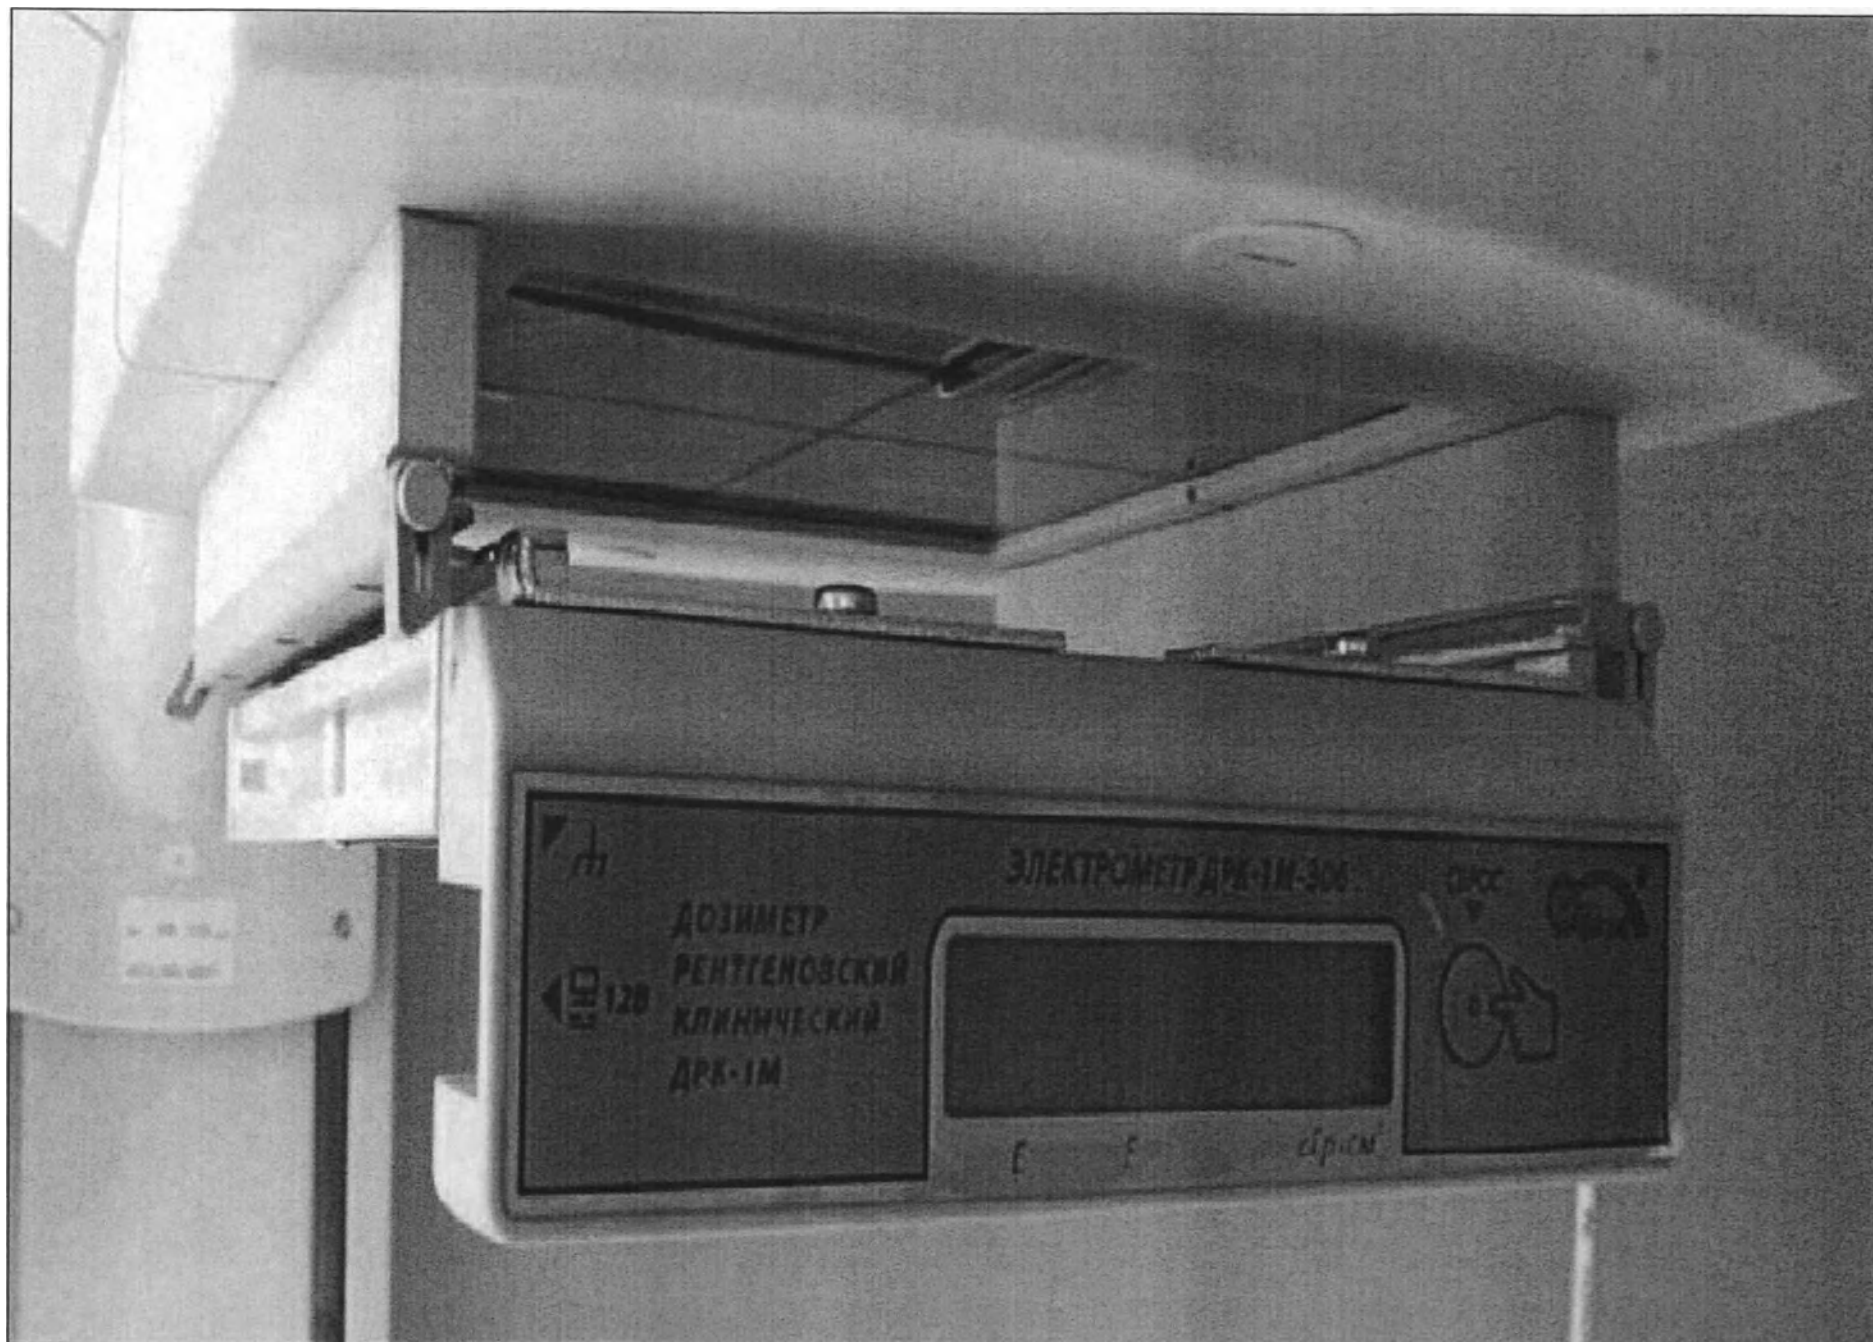


16.г. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

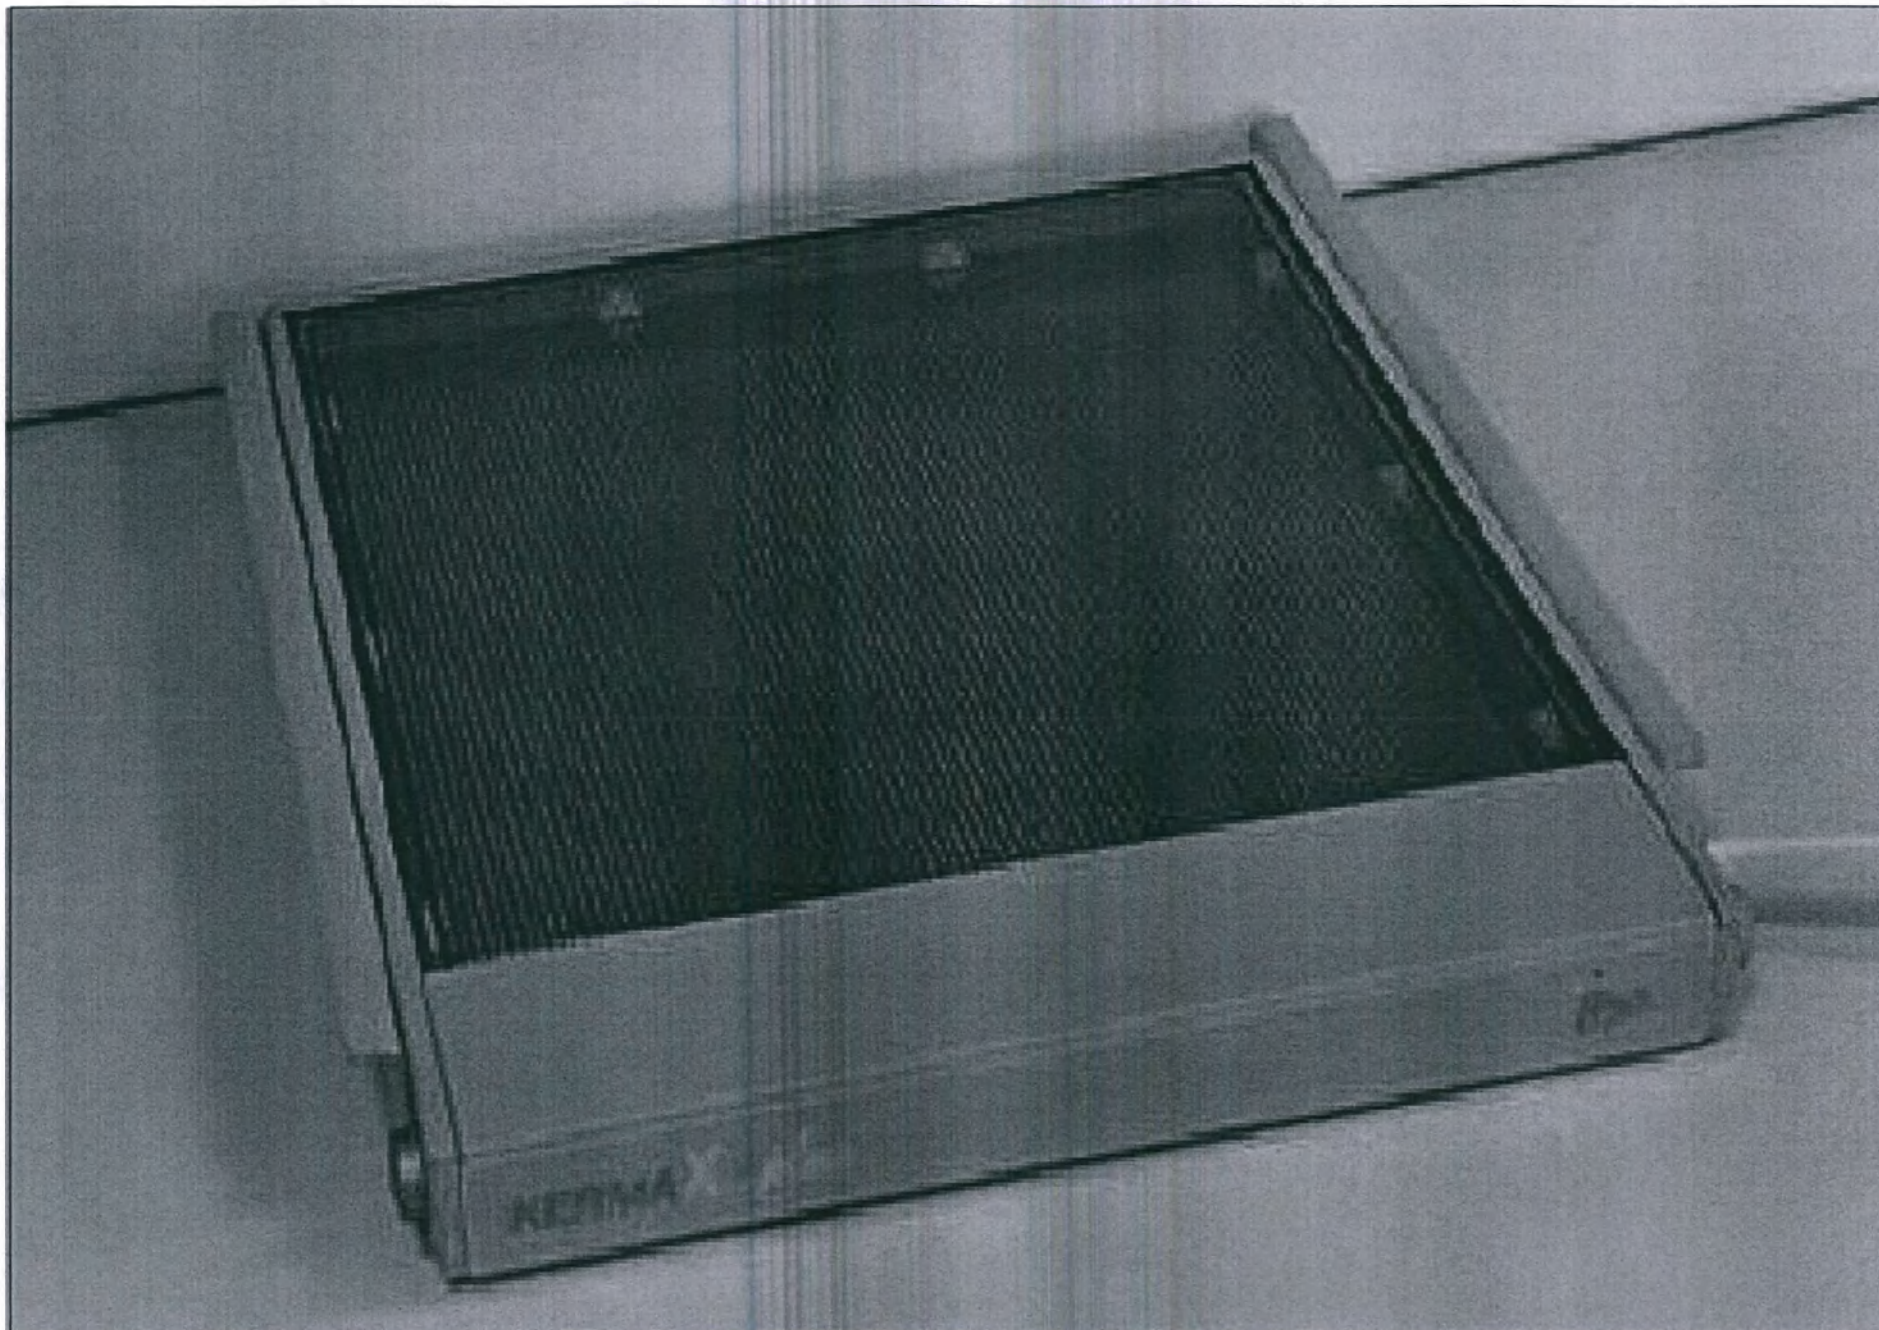

17. Измеритель производства дозы на площадь Kertax plus 120-132.

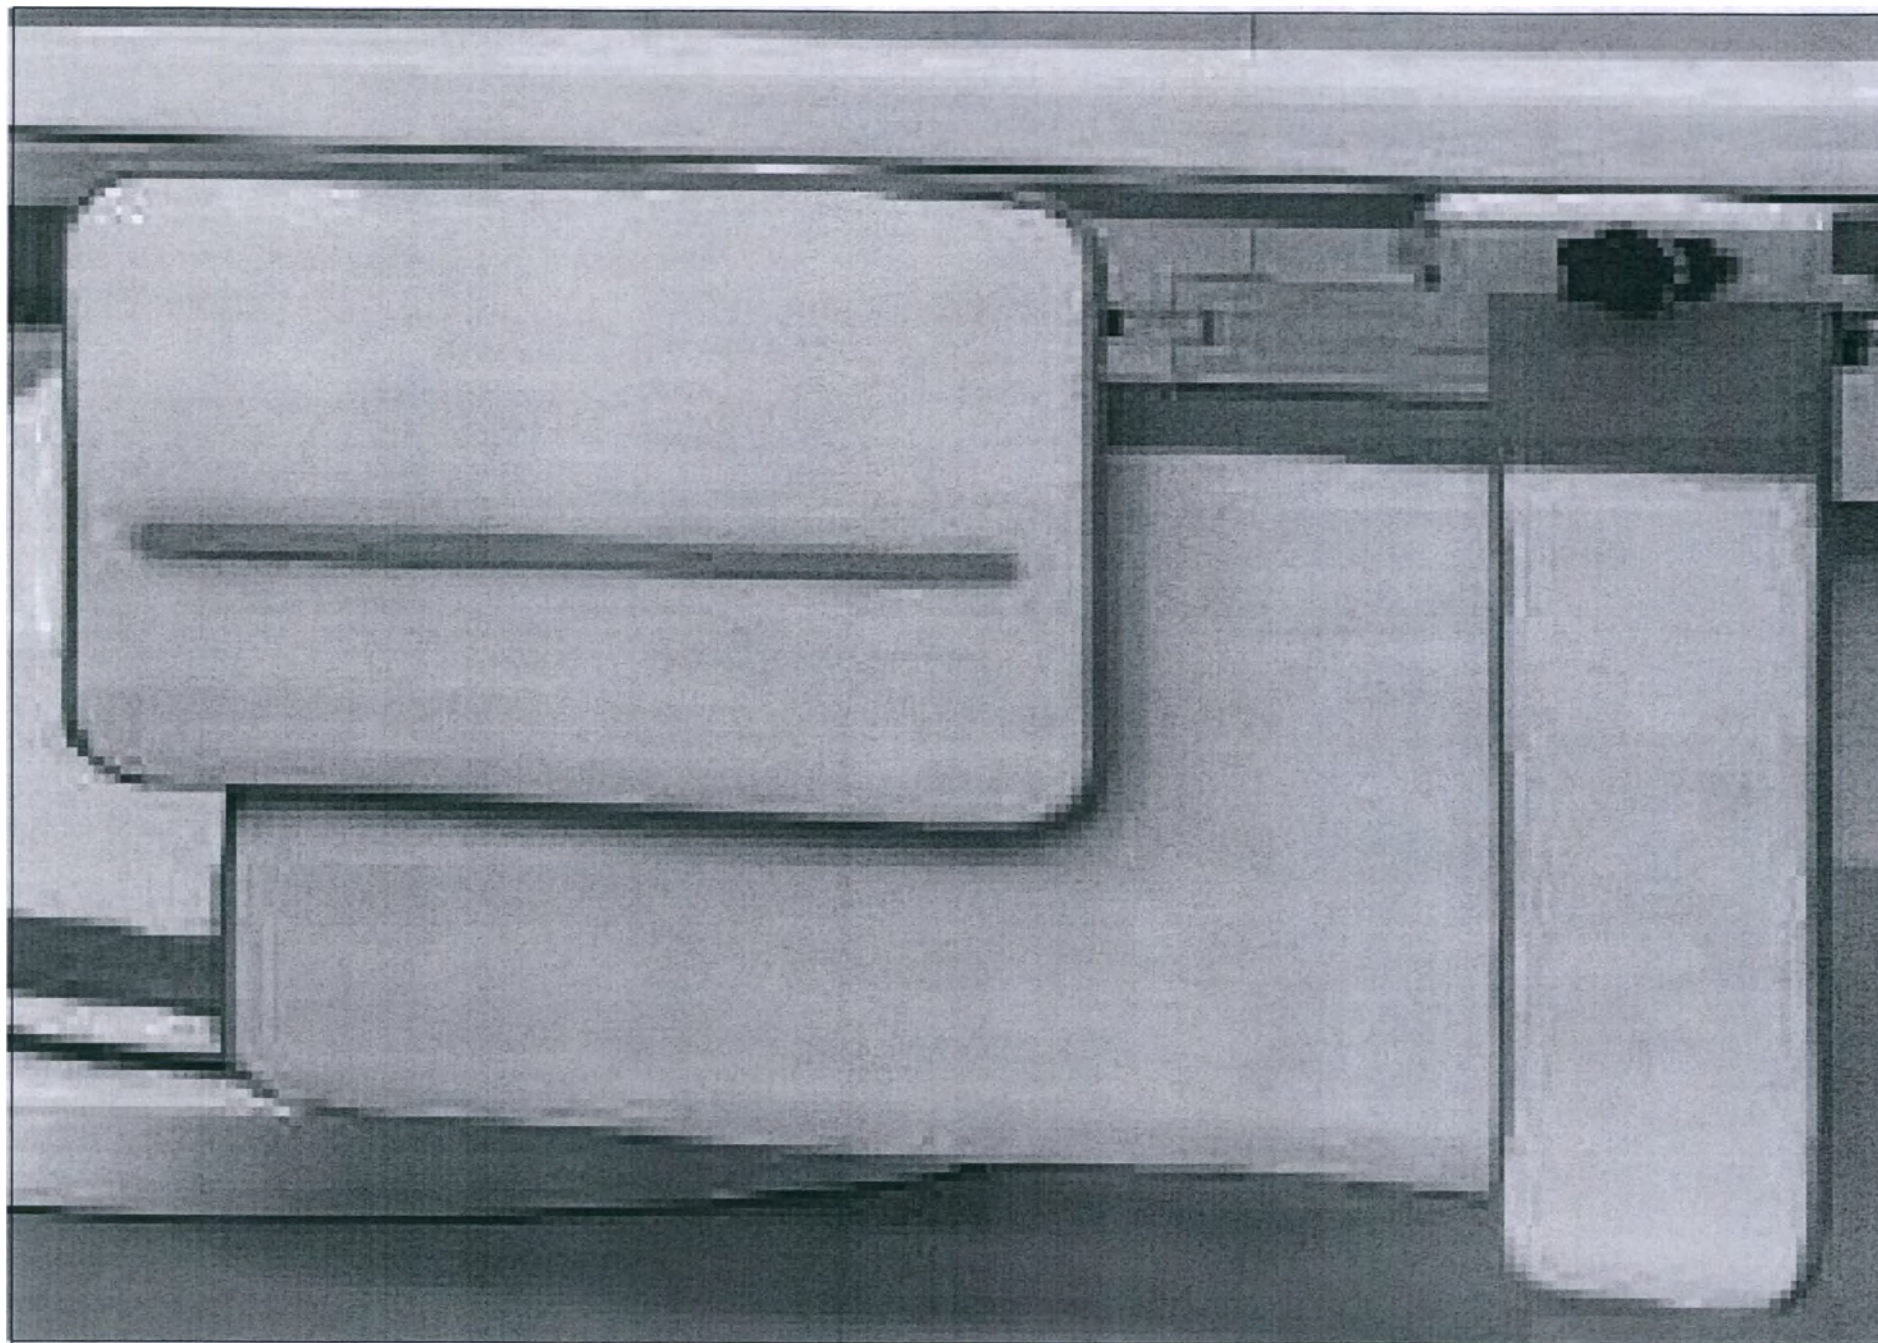


18. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

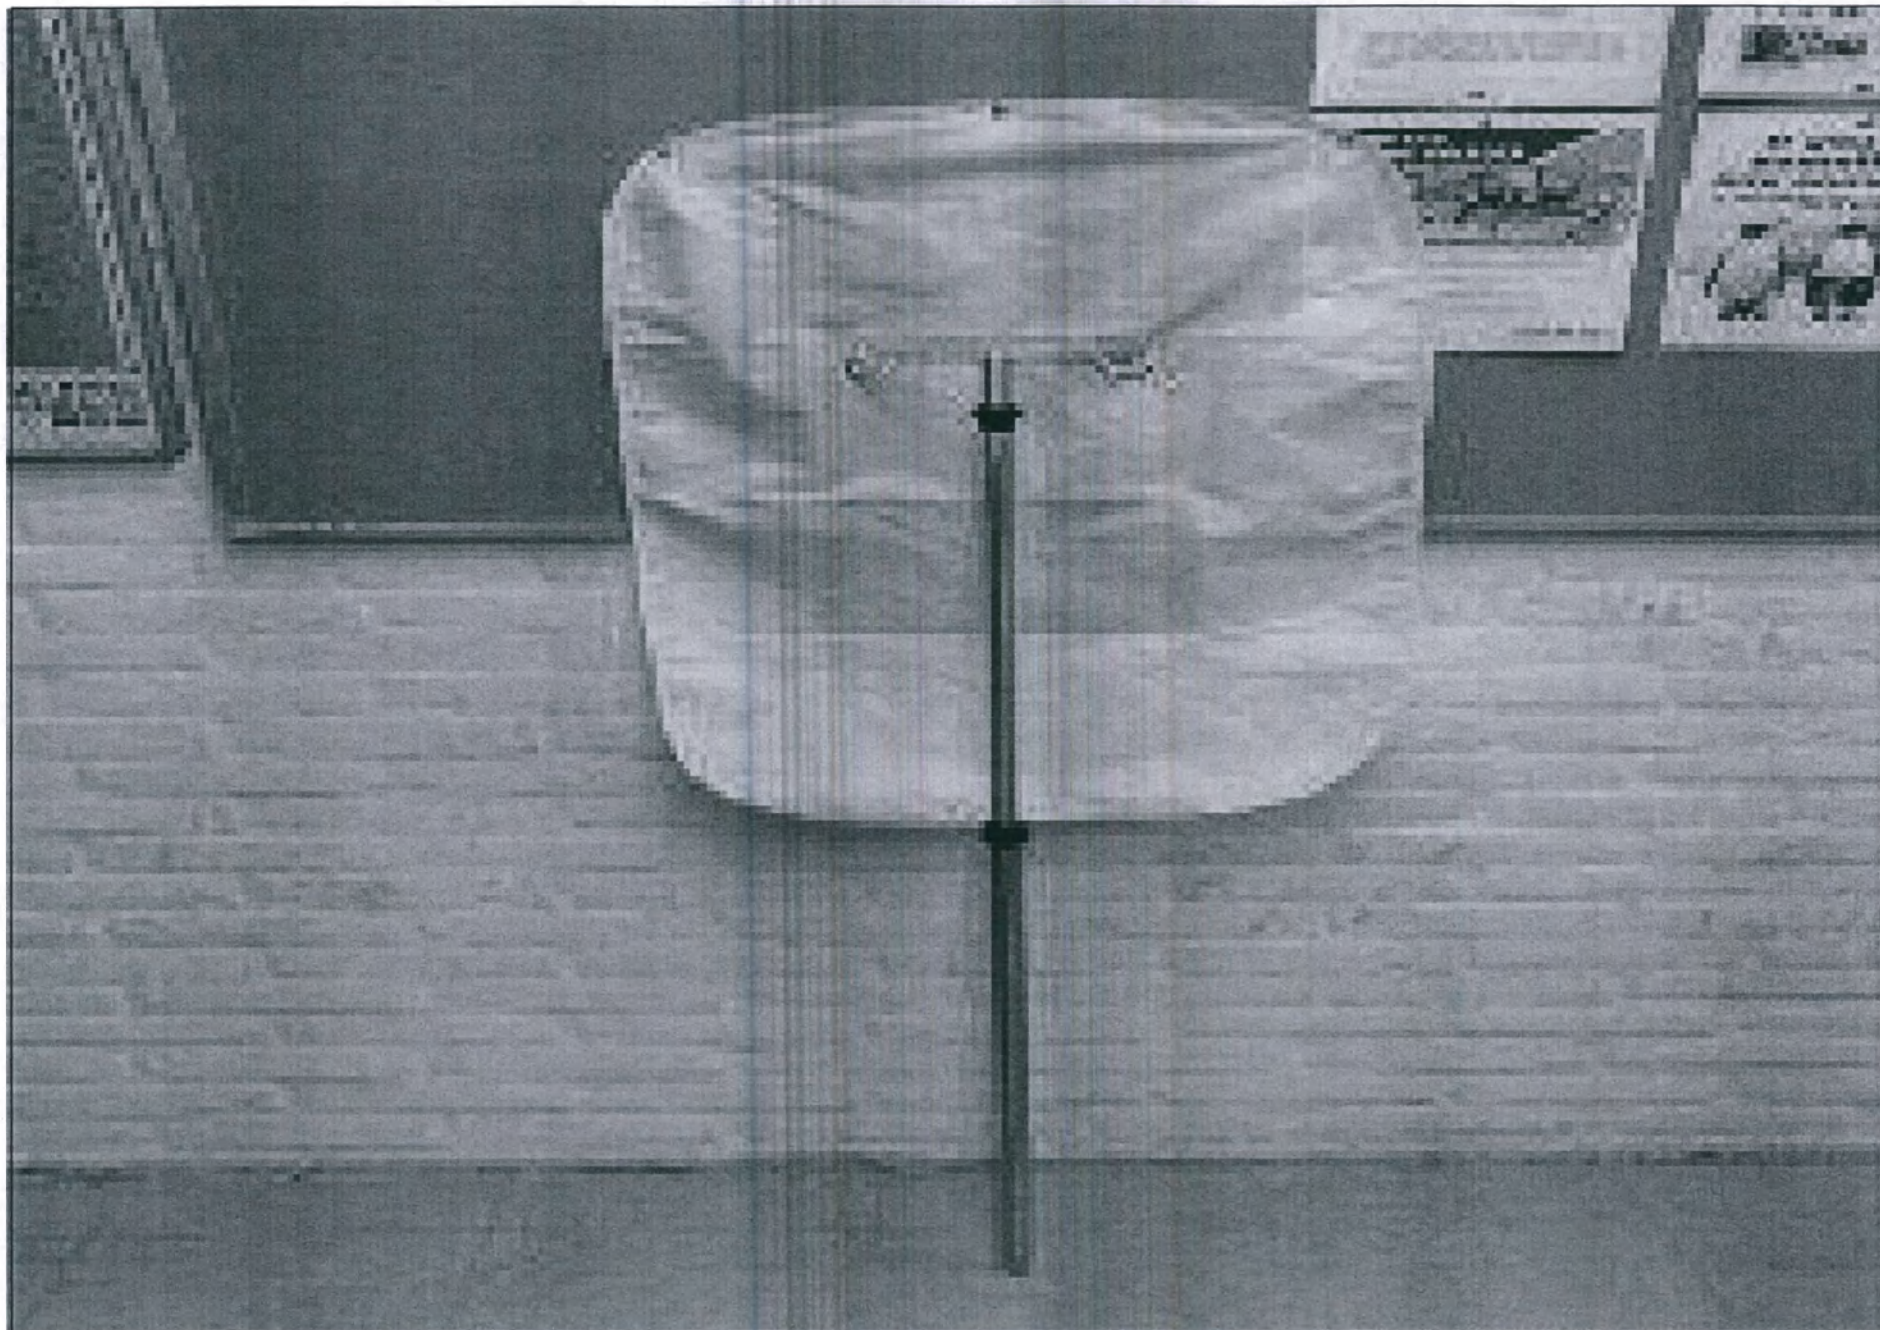

19. Штатив для капельницы, не более 2 шт.



20. Лампа для осмотра.

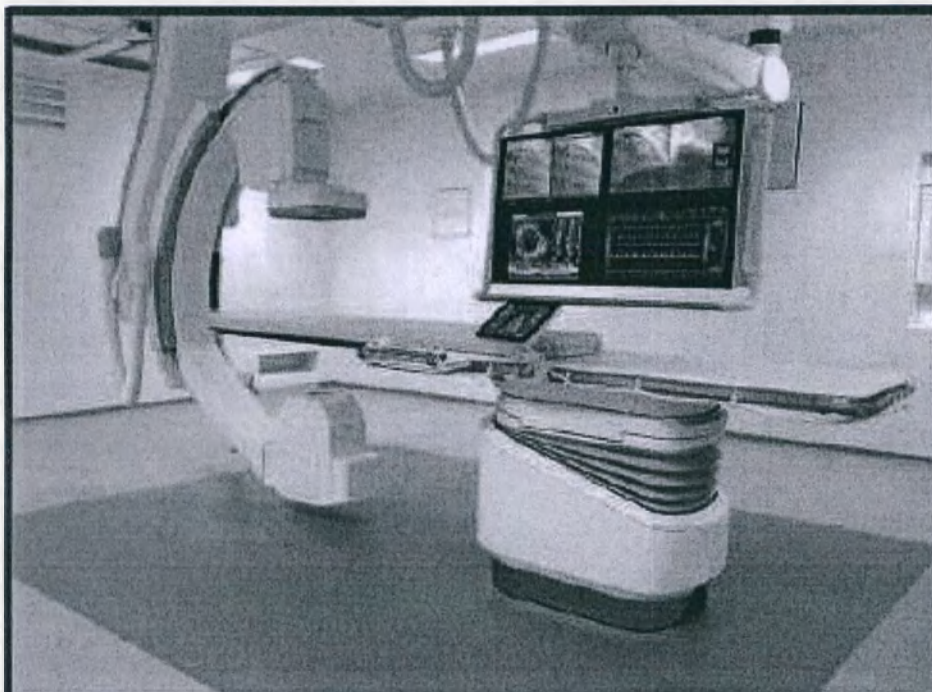

Руководство по
эксплуатации

Русский

4522 203 52651


Azurion

Версия 1.2


PHILIPS

22. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 7 B20 (вариант 1):

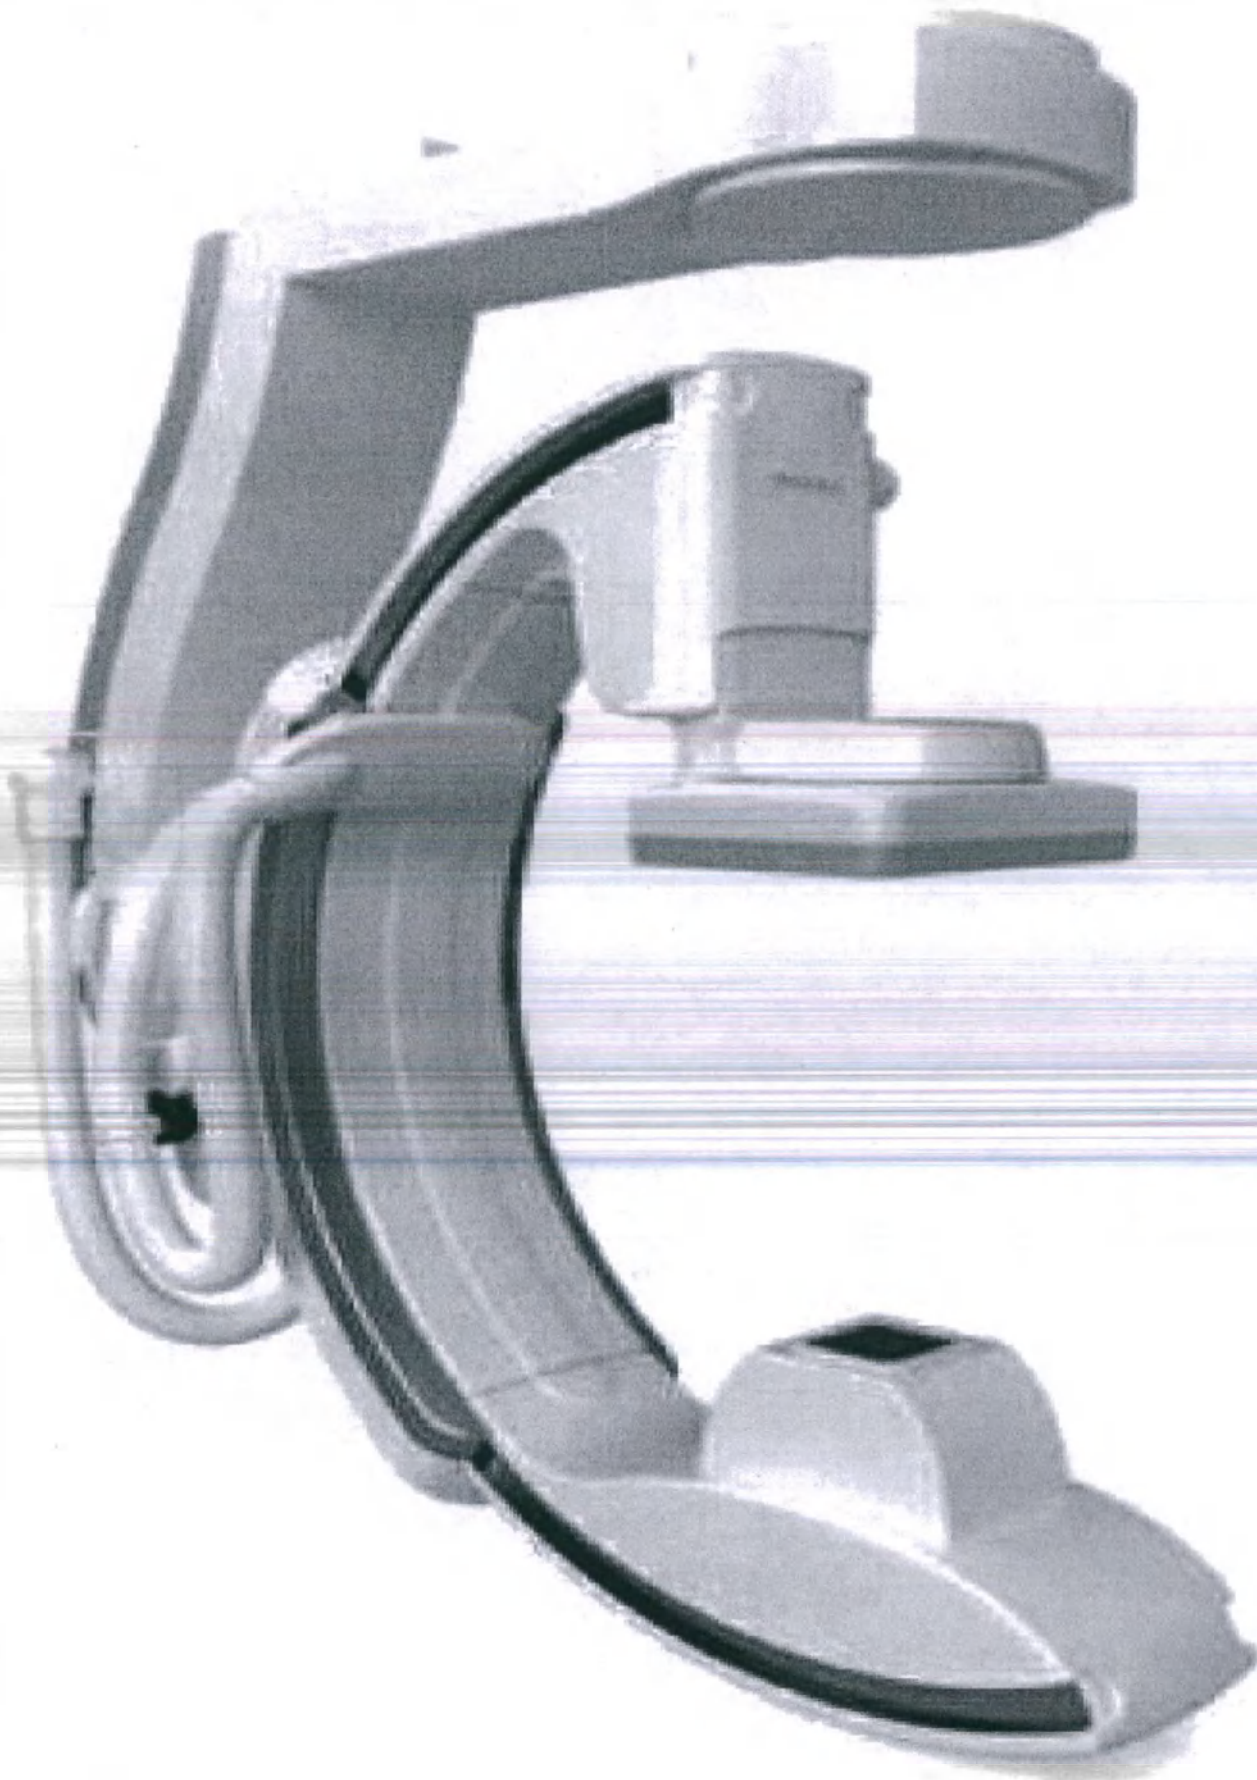


1. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

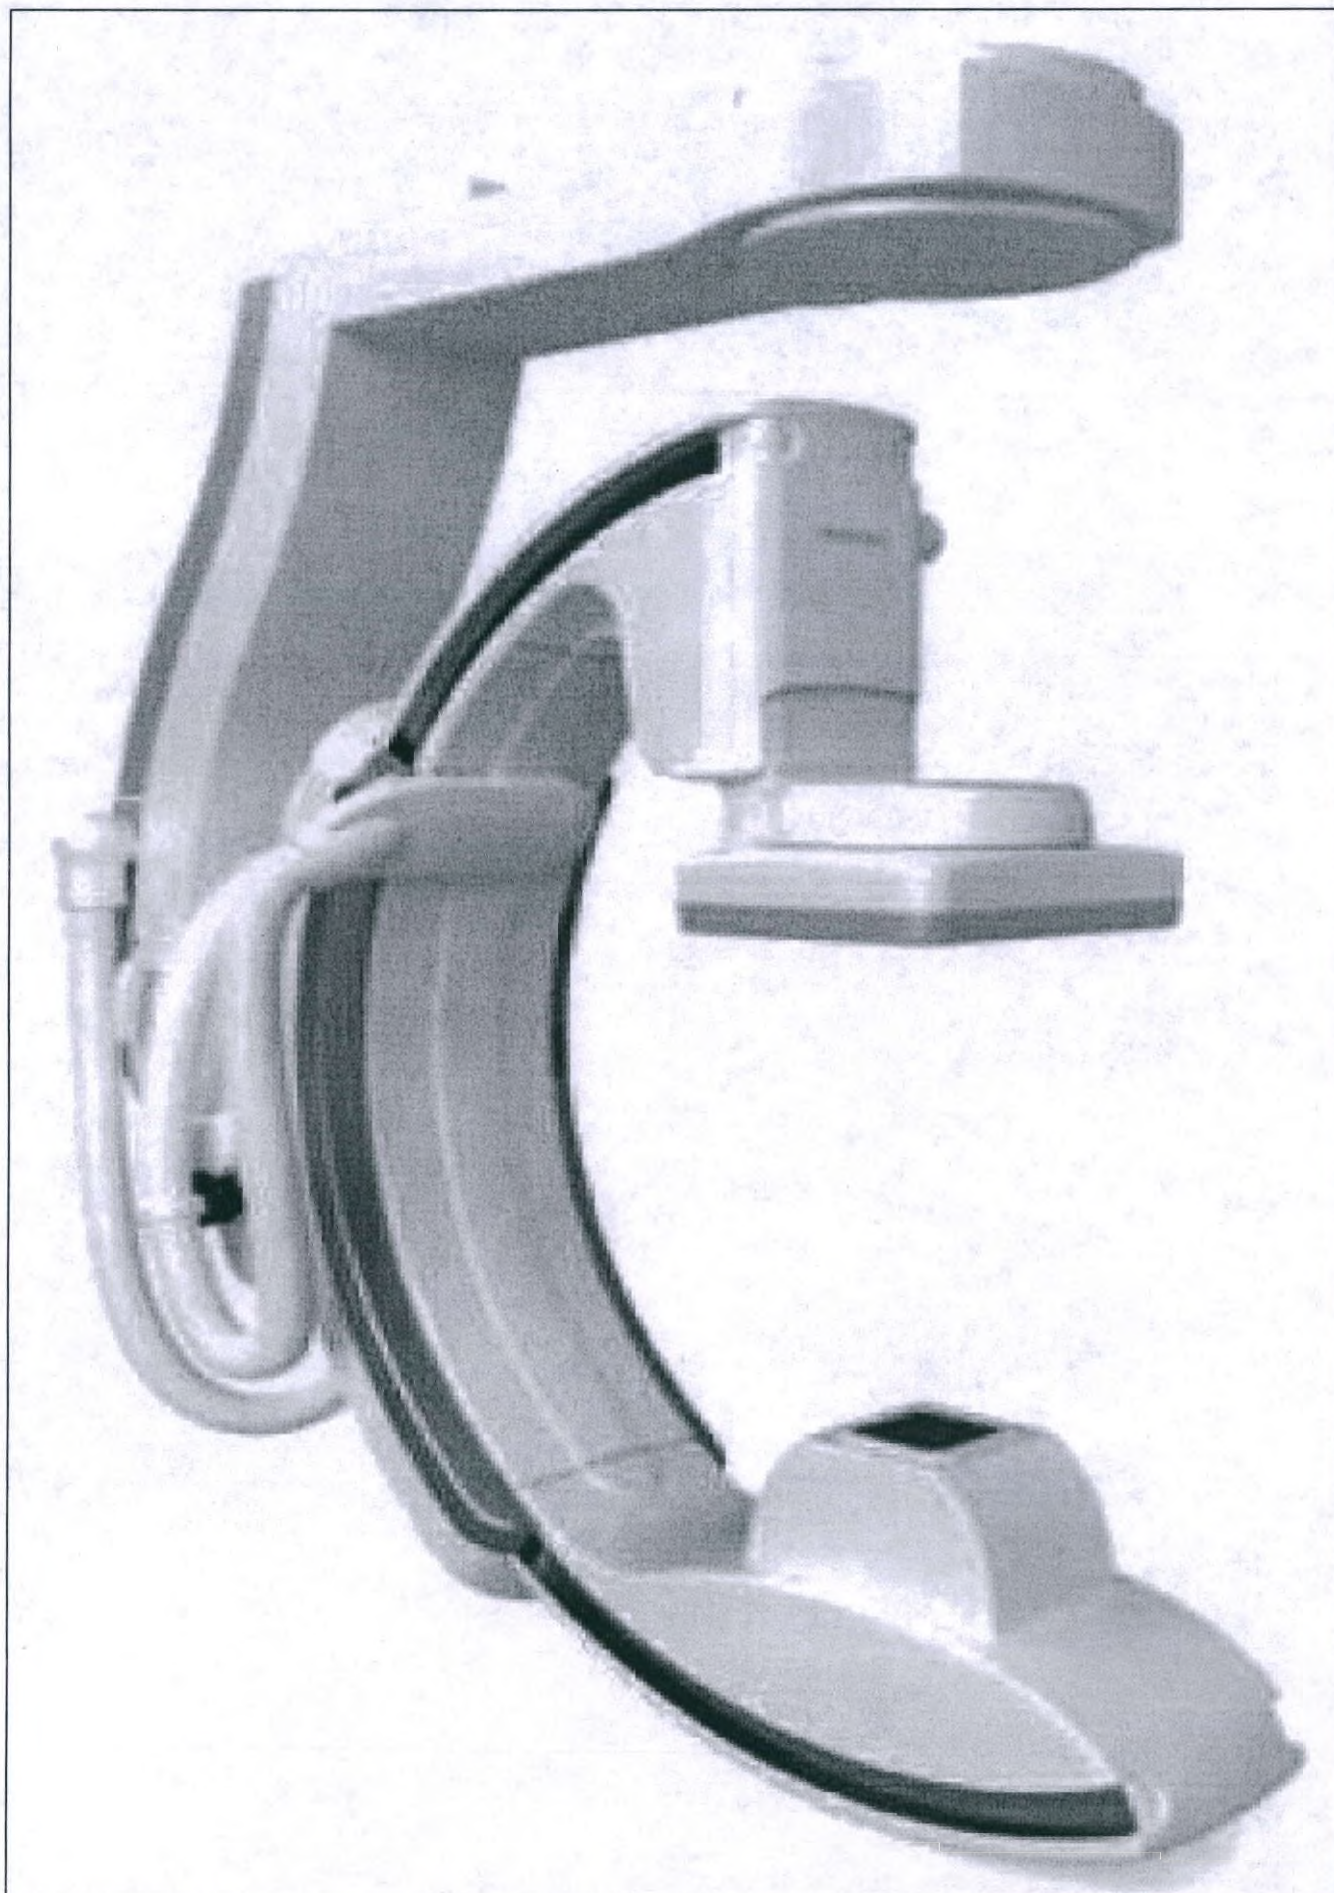


1.а. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

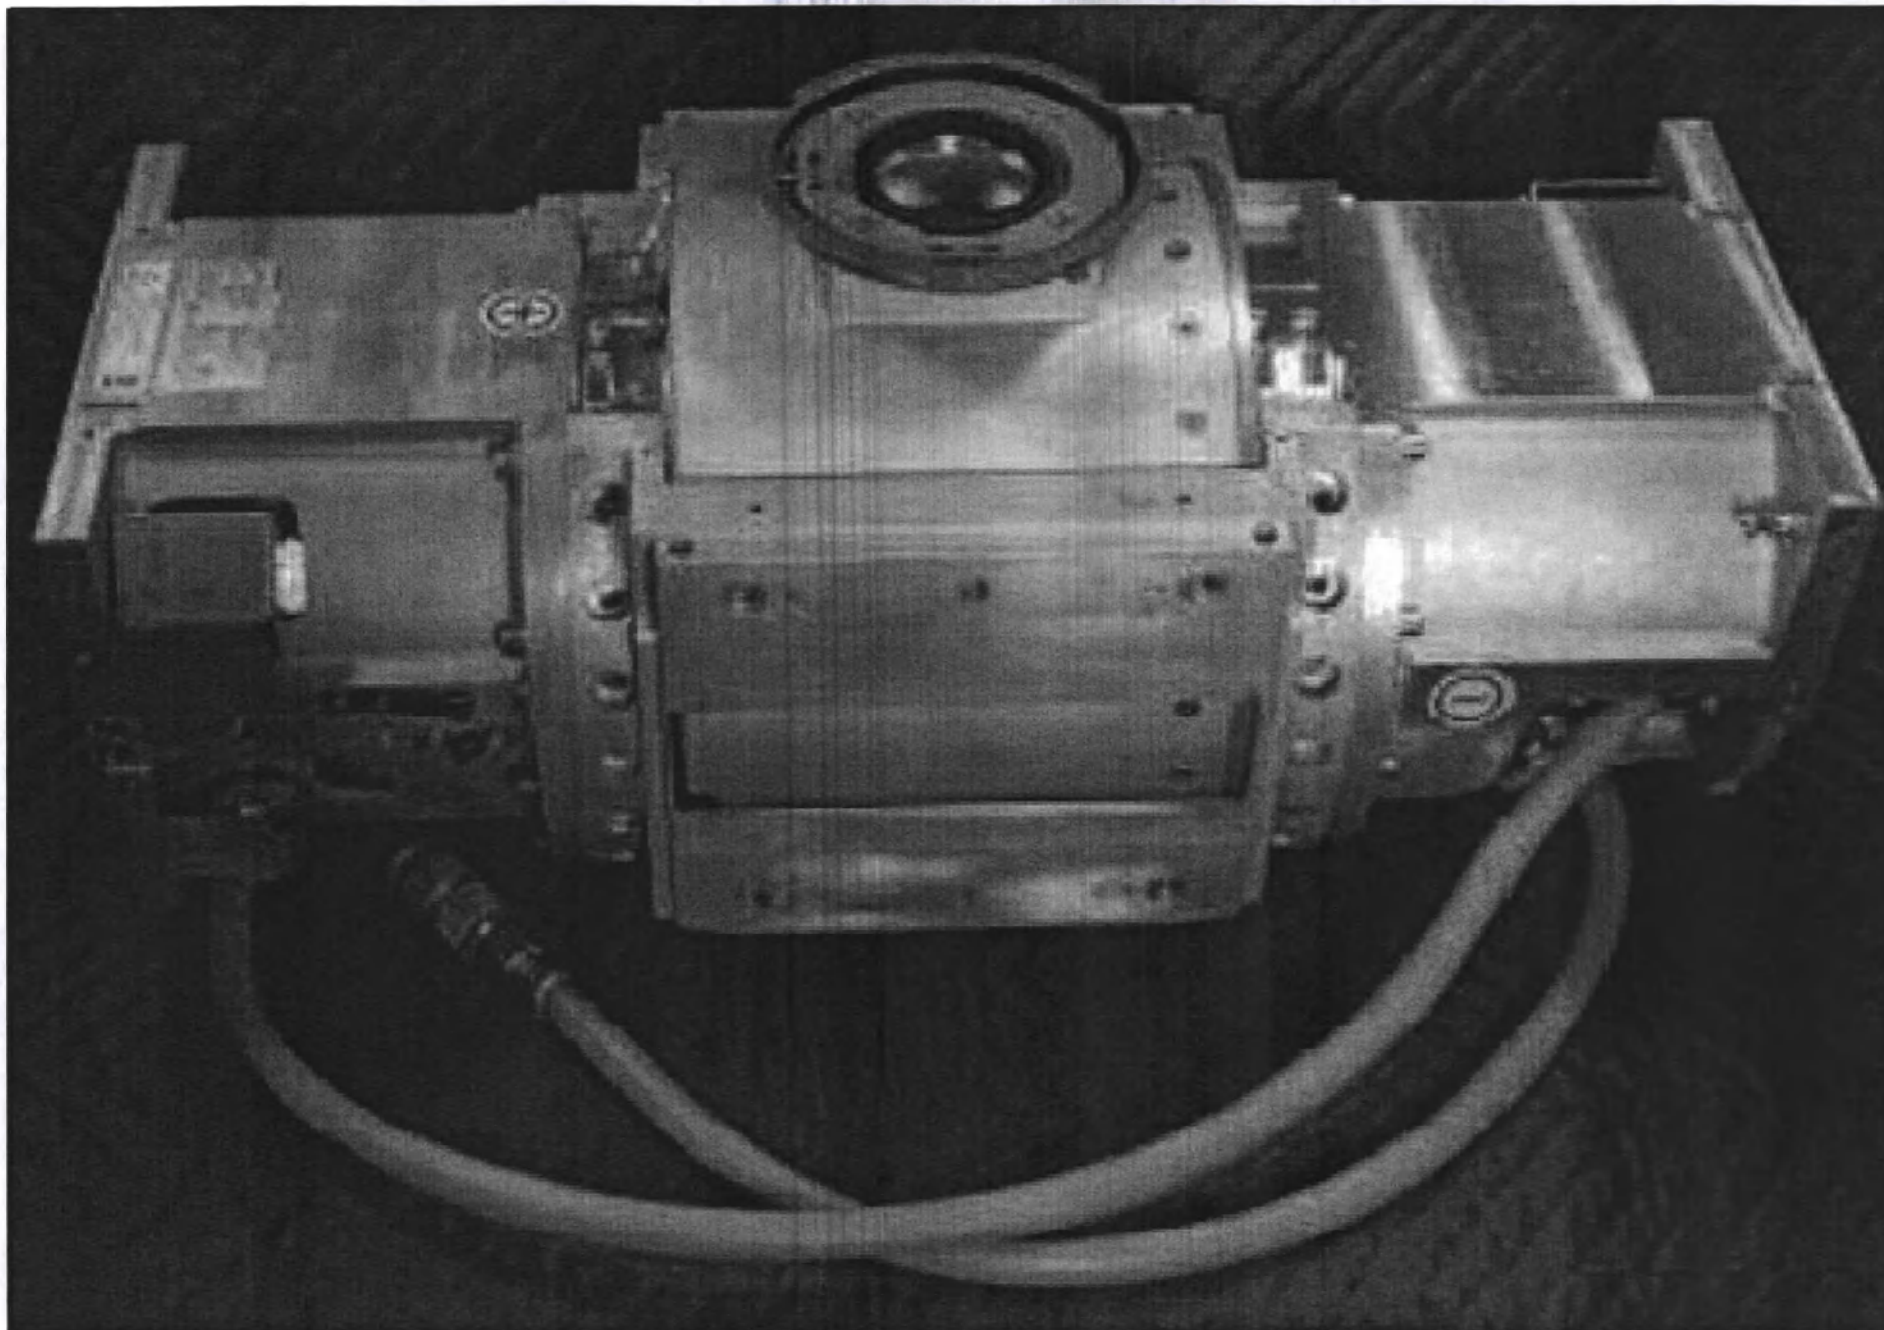


1.6. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

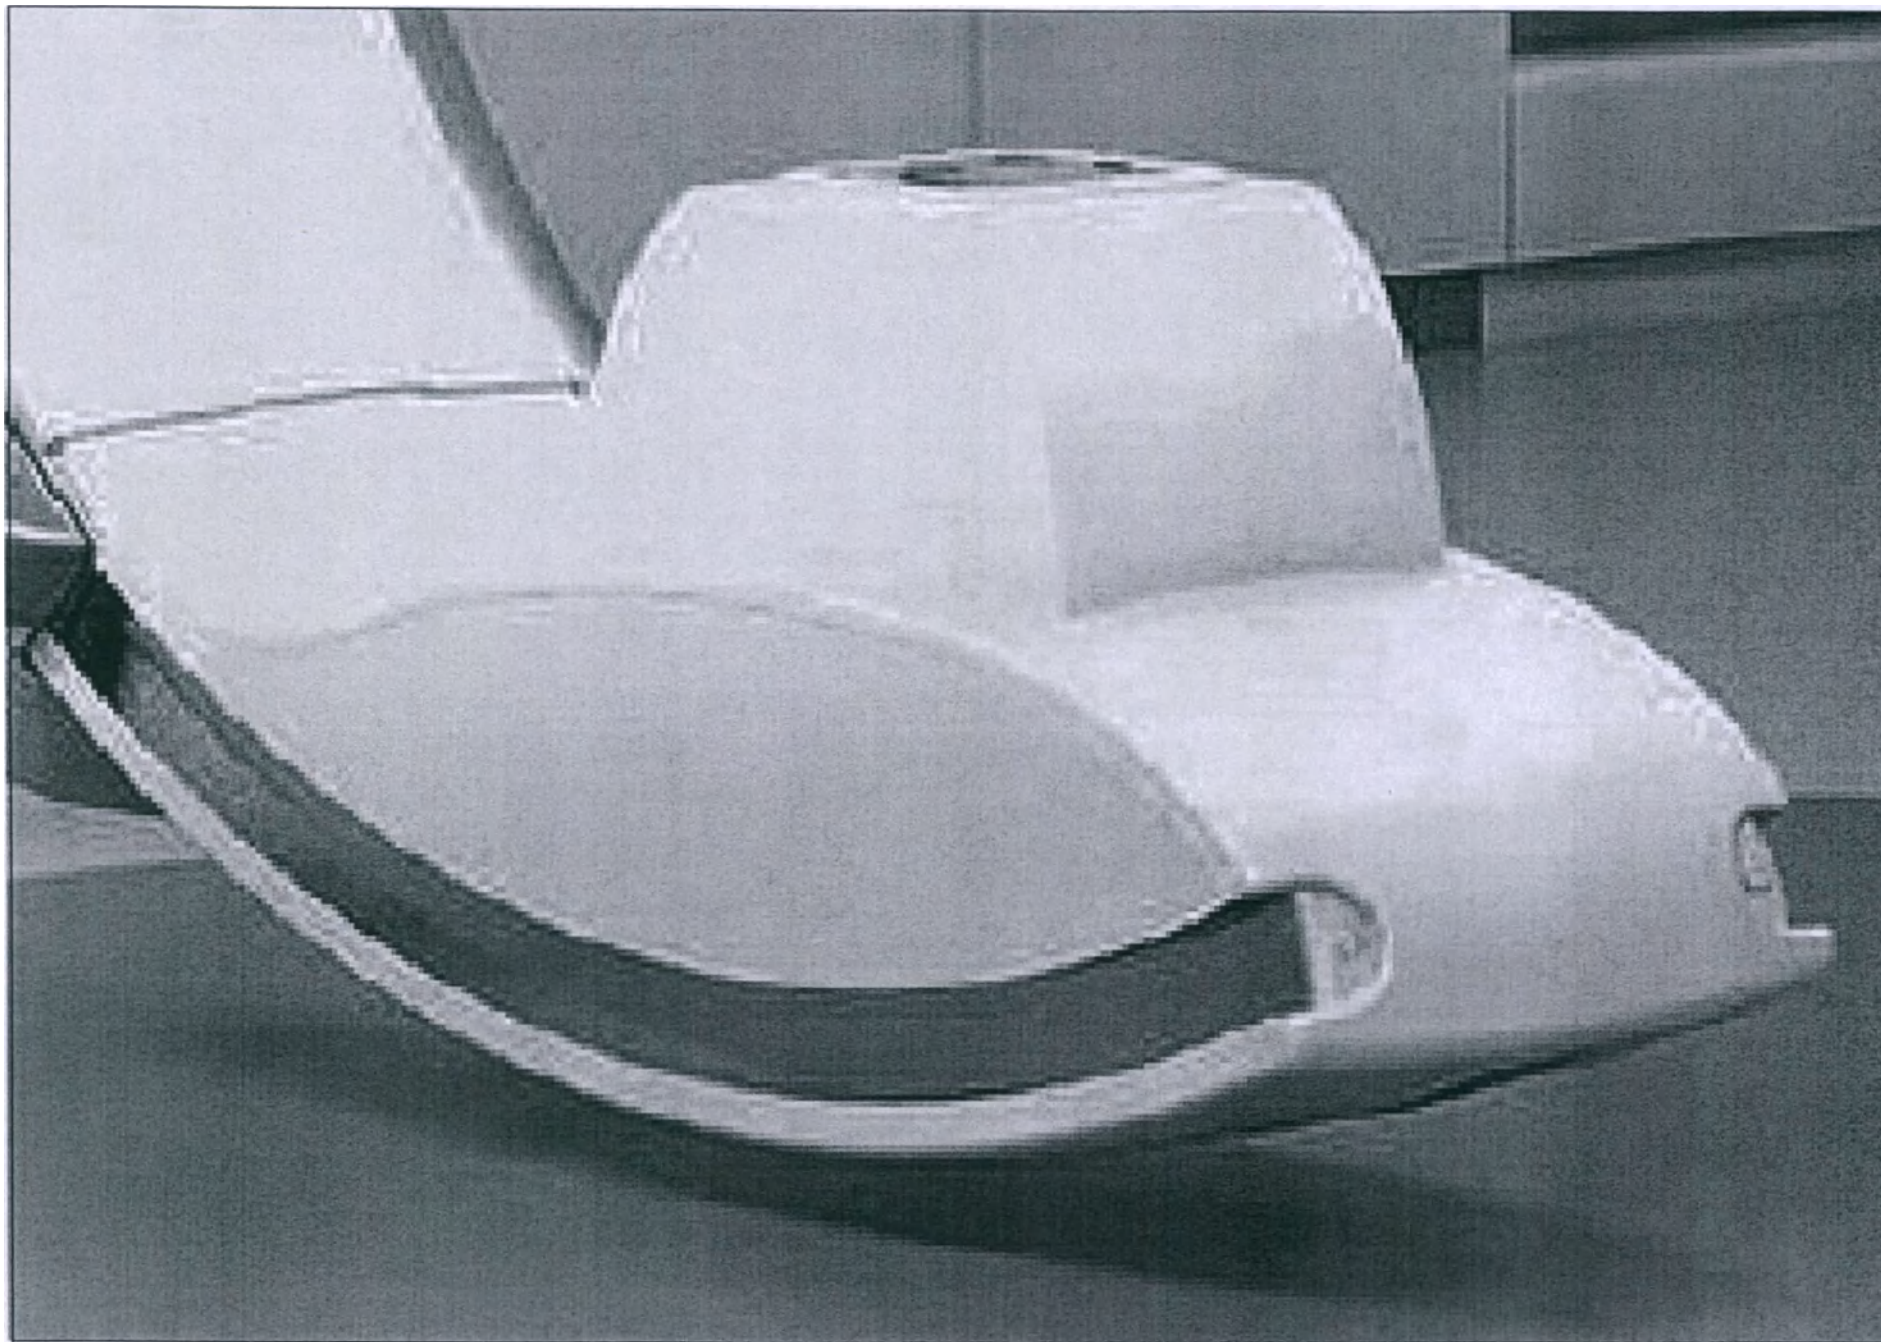


1.в. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

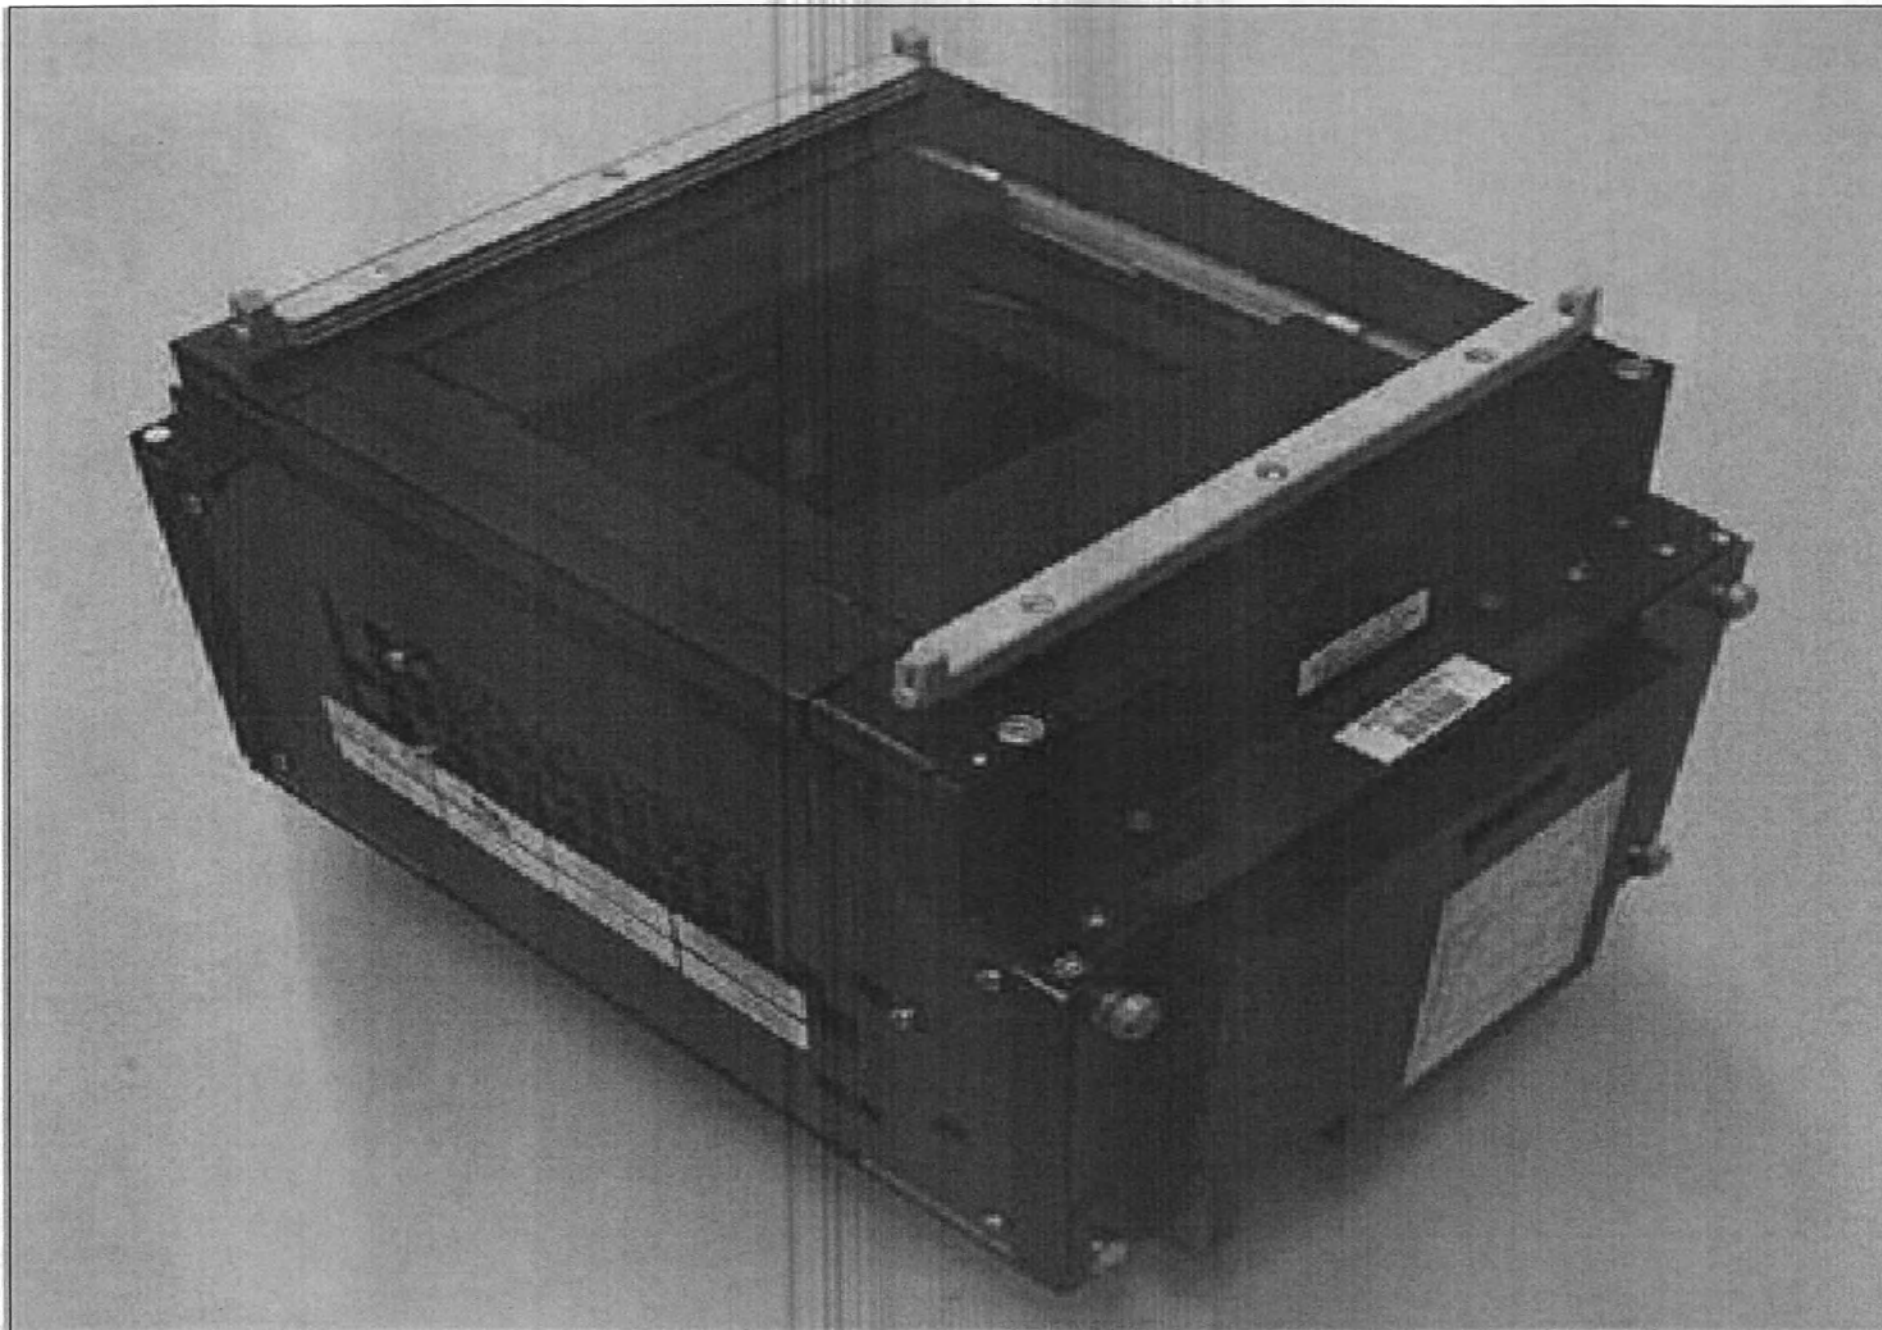


1.2. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

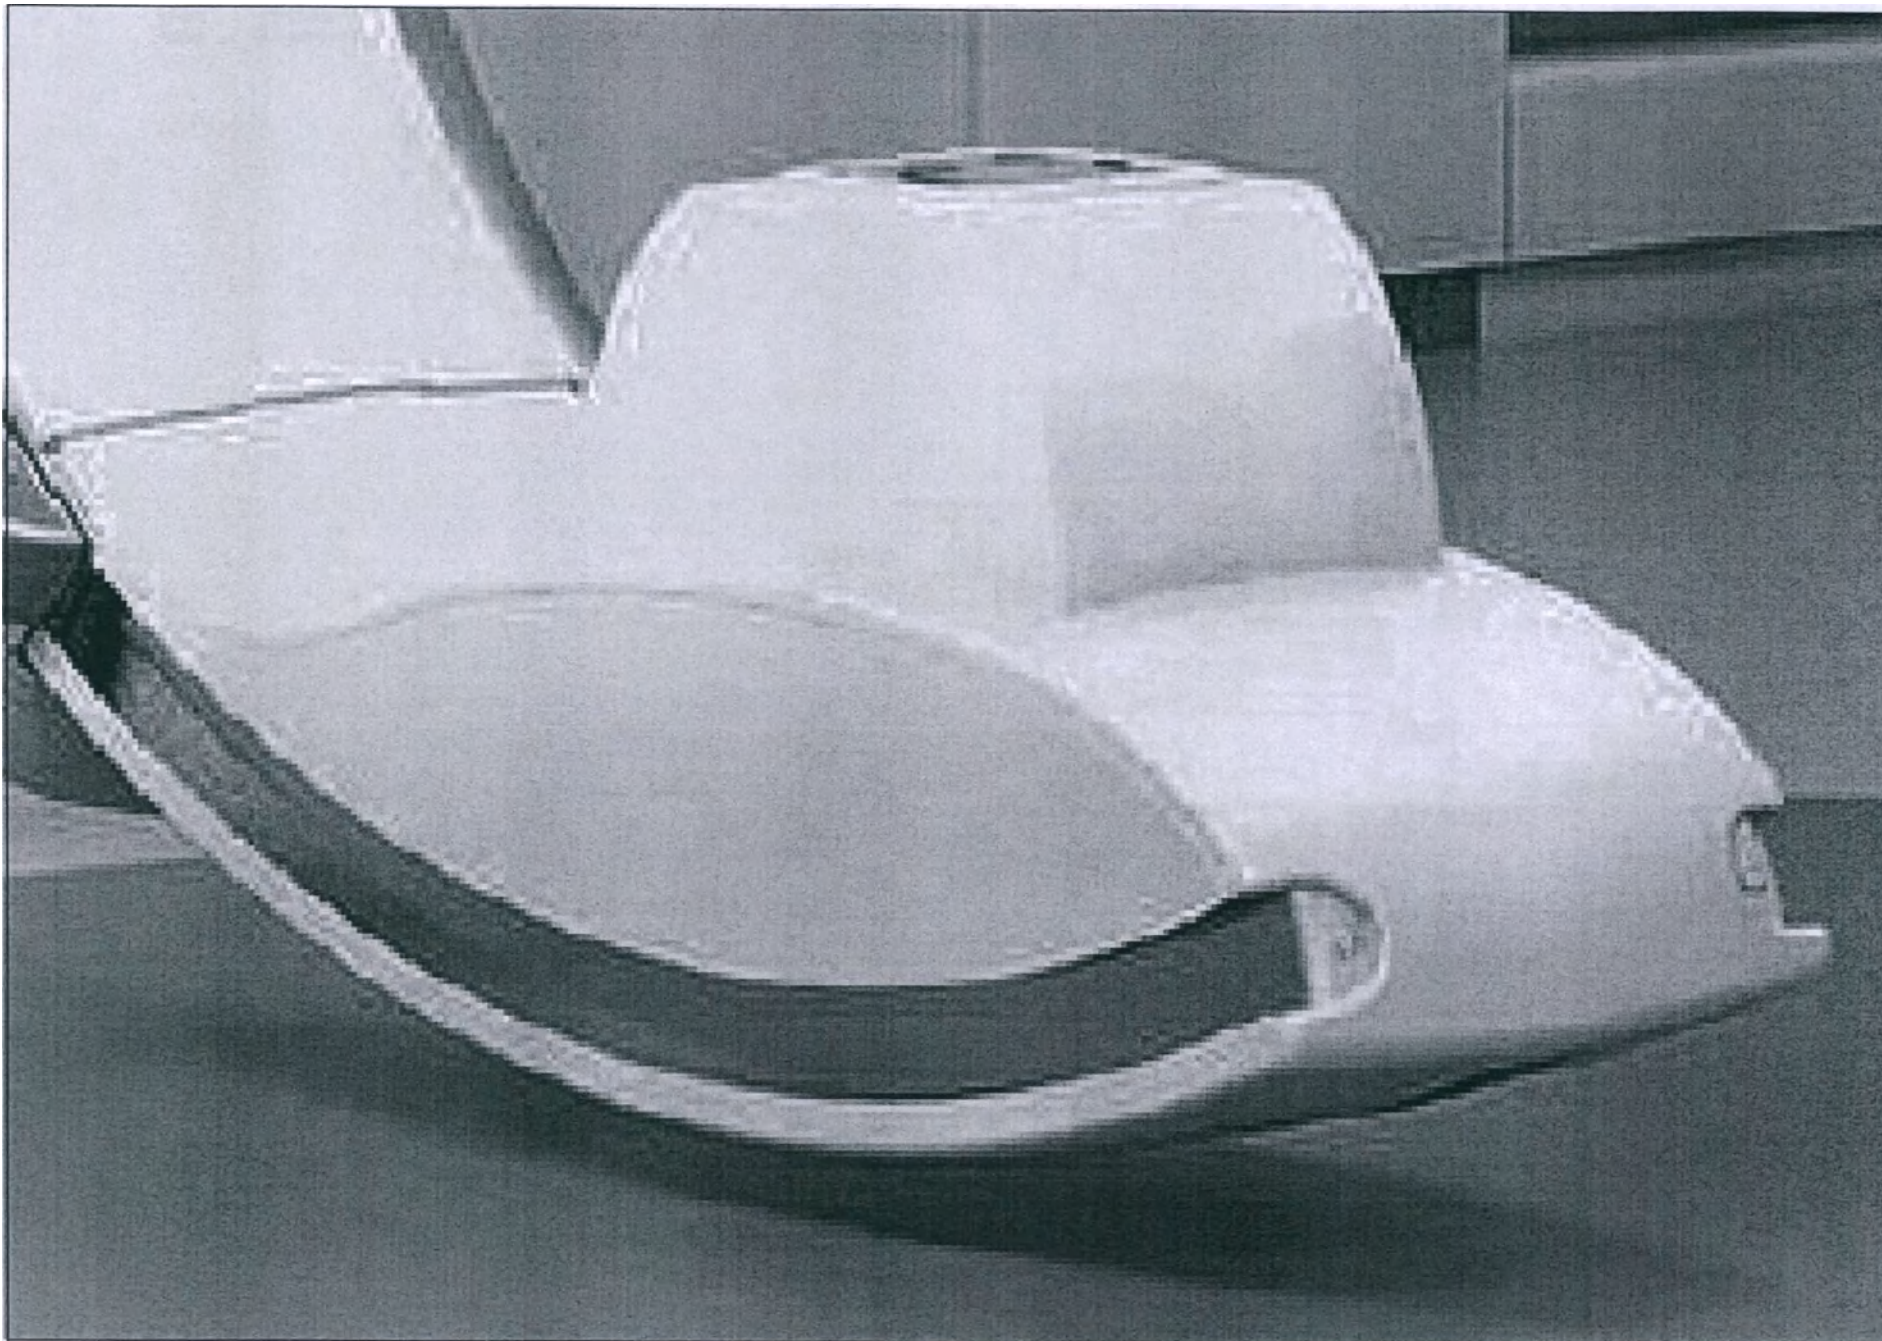


1.д. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

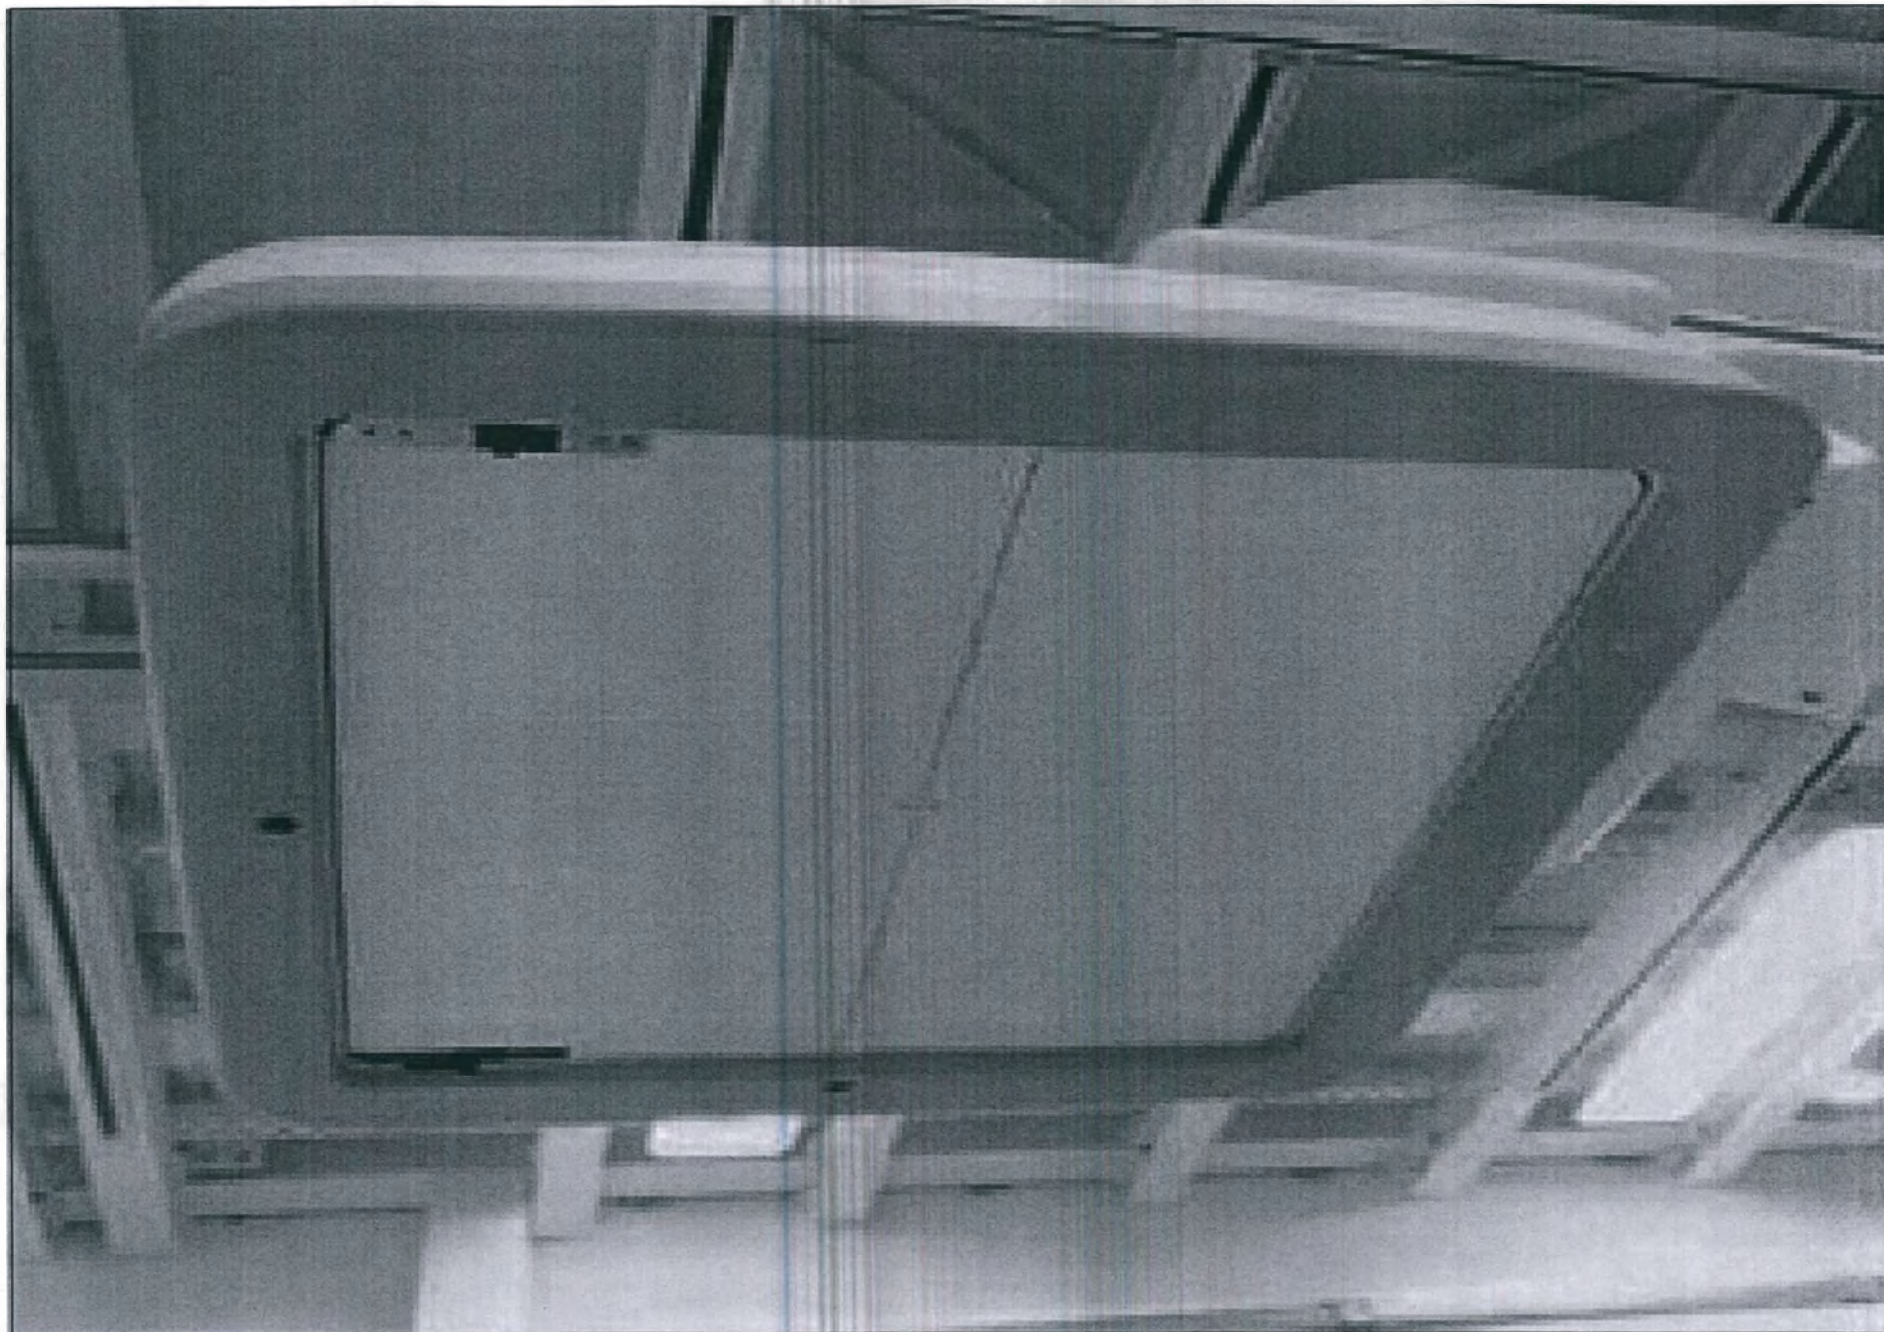


1.е. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

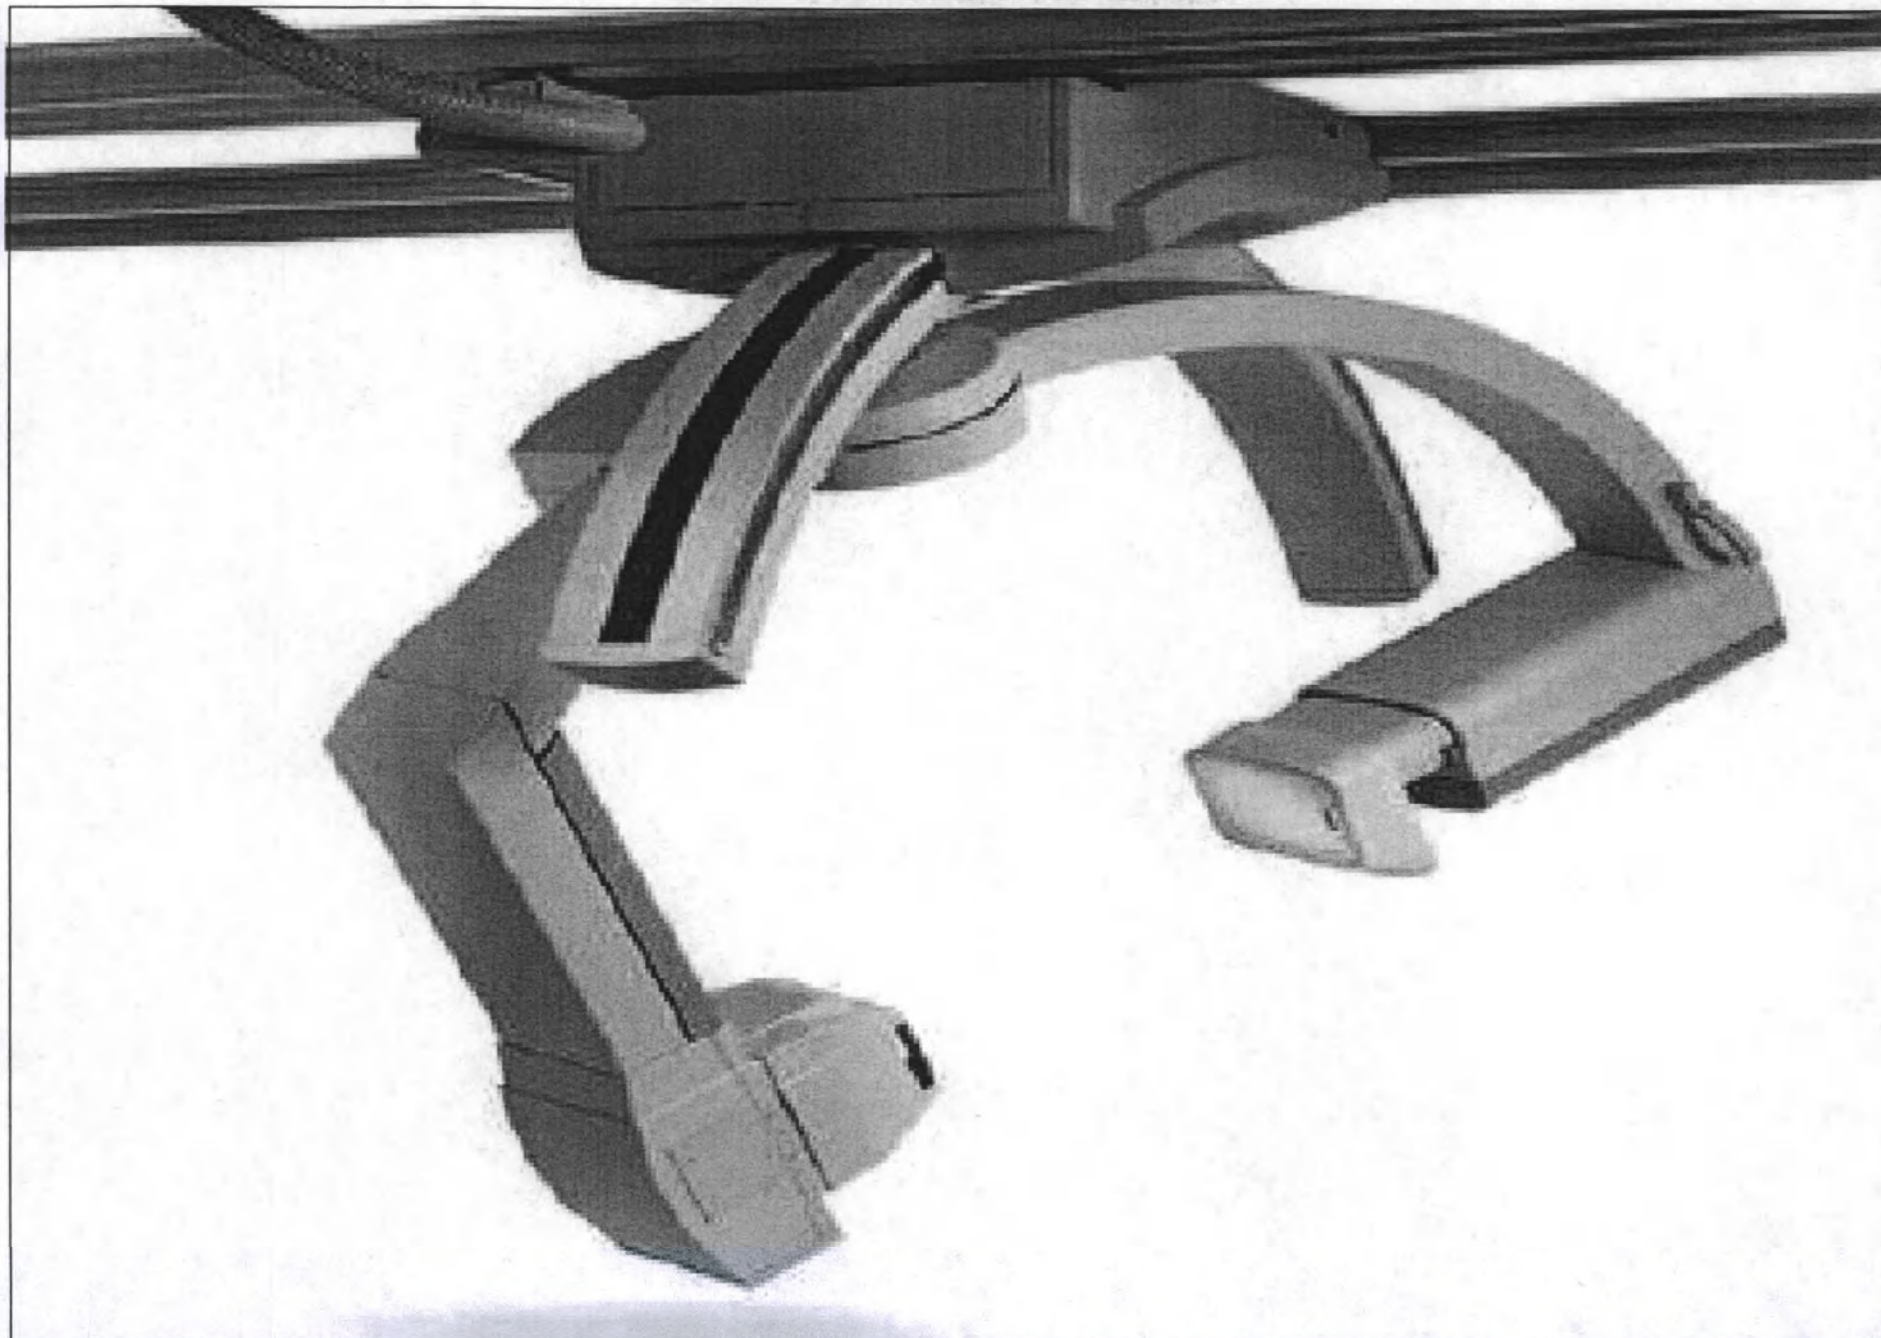


2.а. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C15.

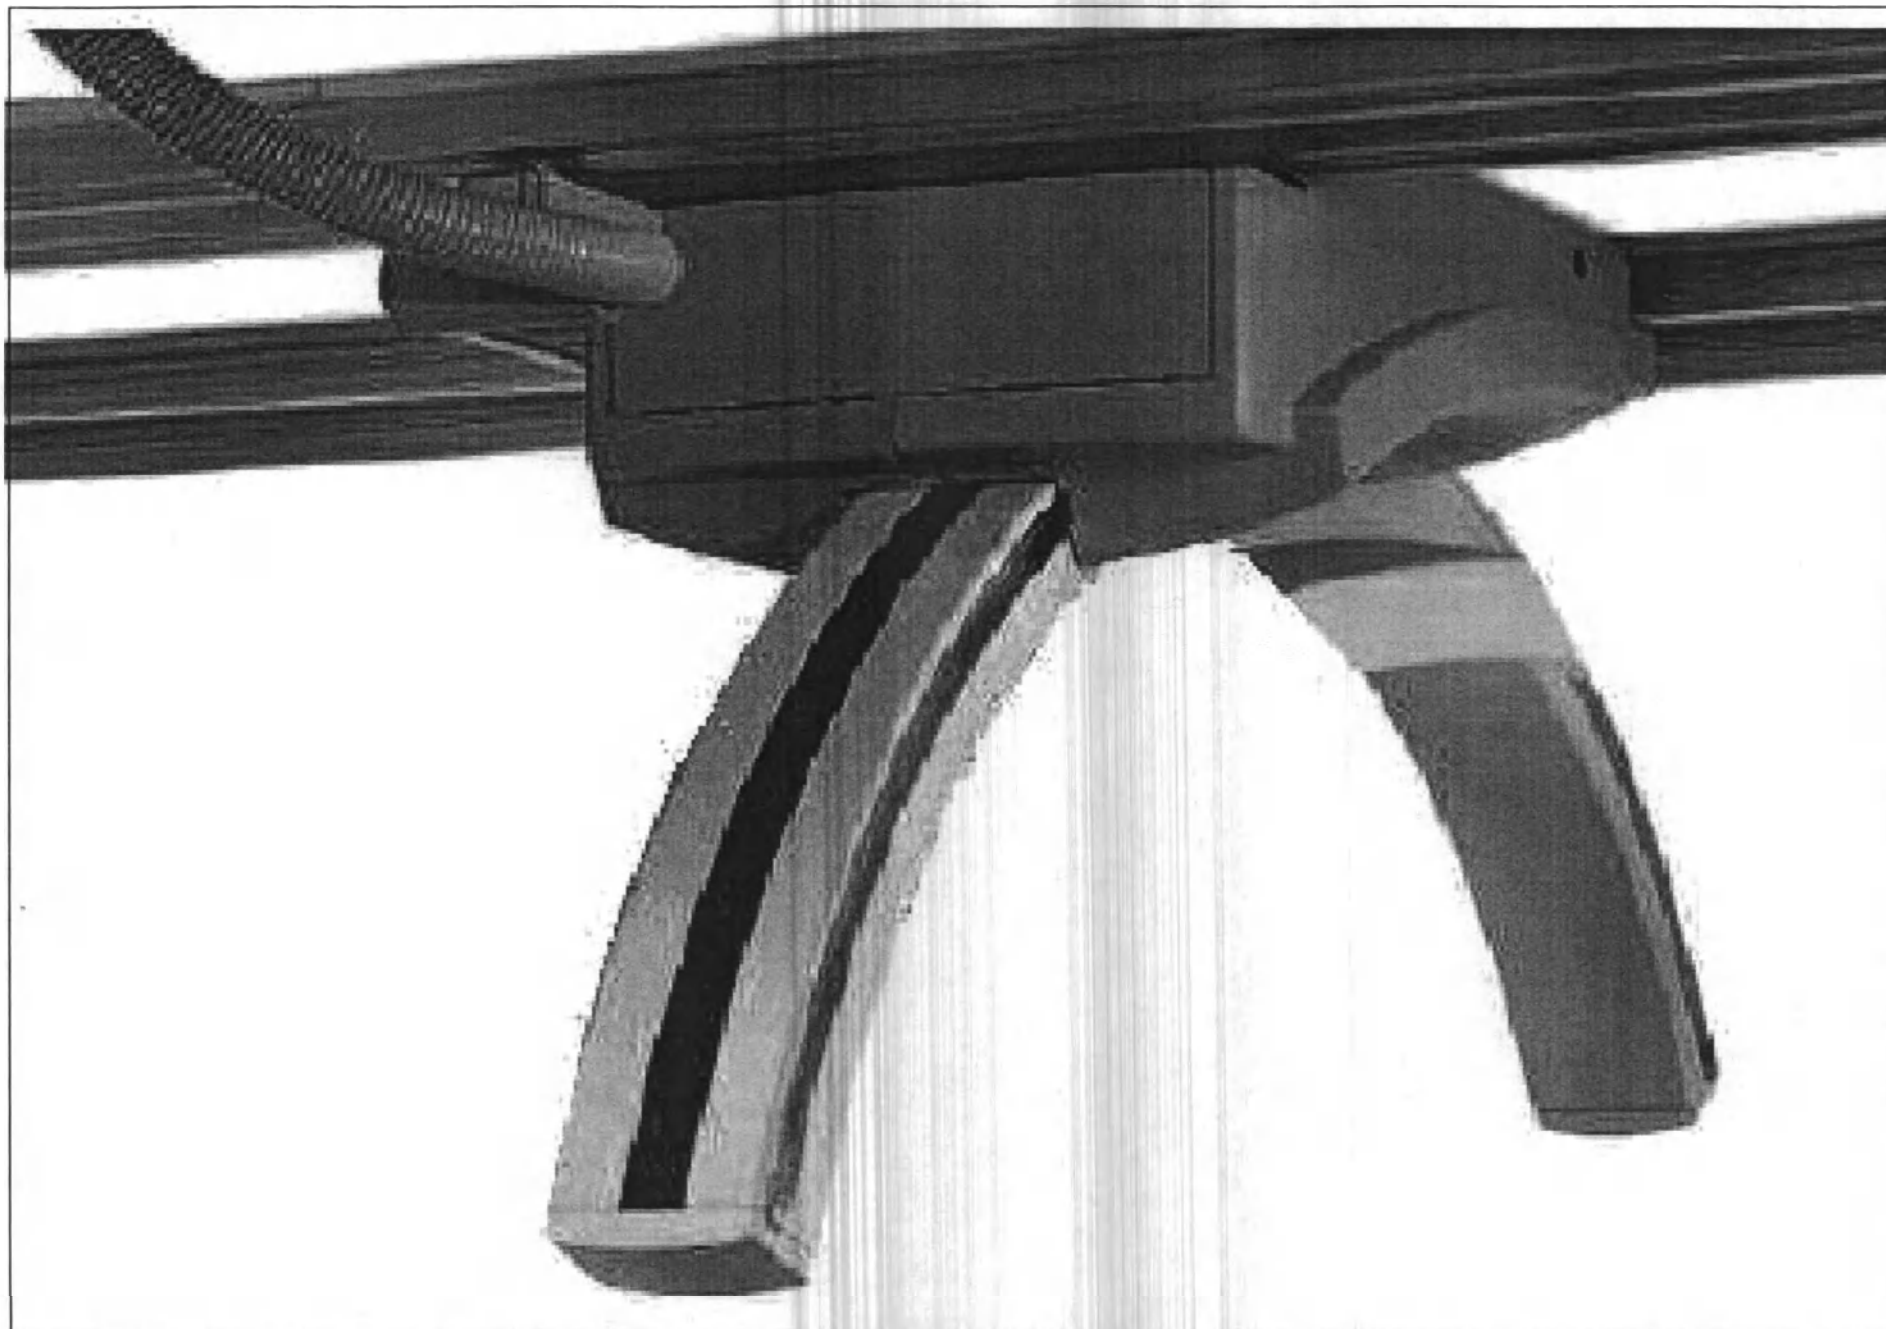


2.6. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C15.

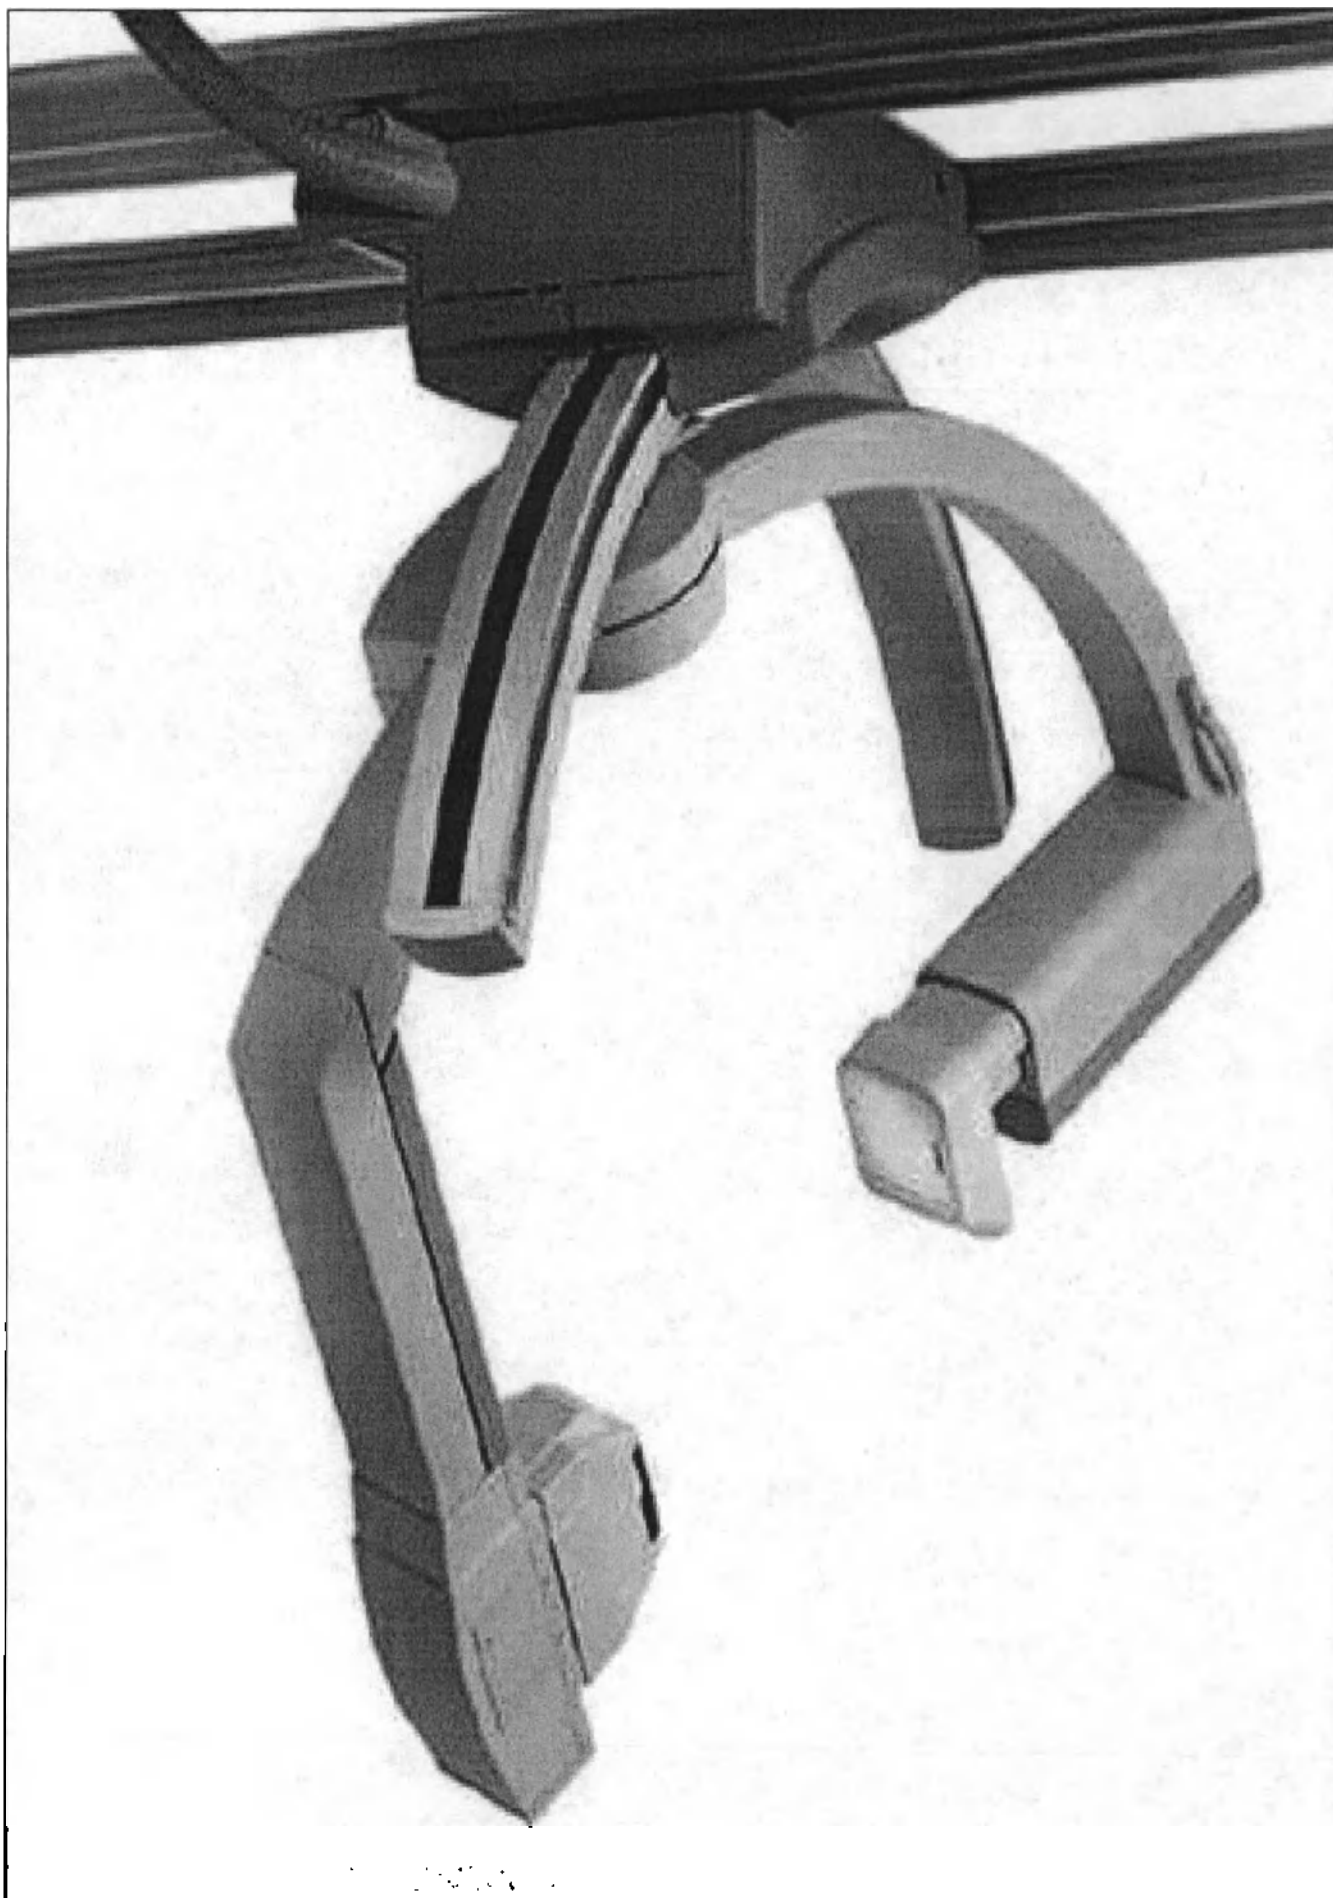


2.в. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C15.

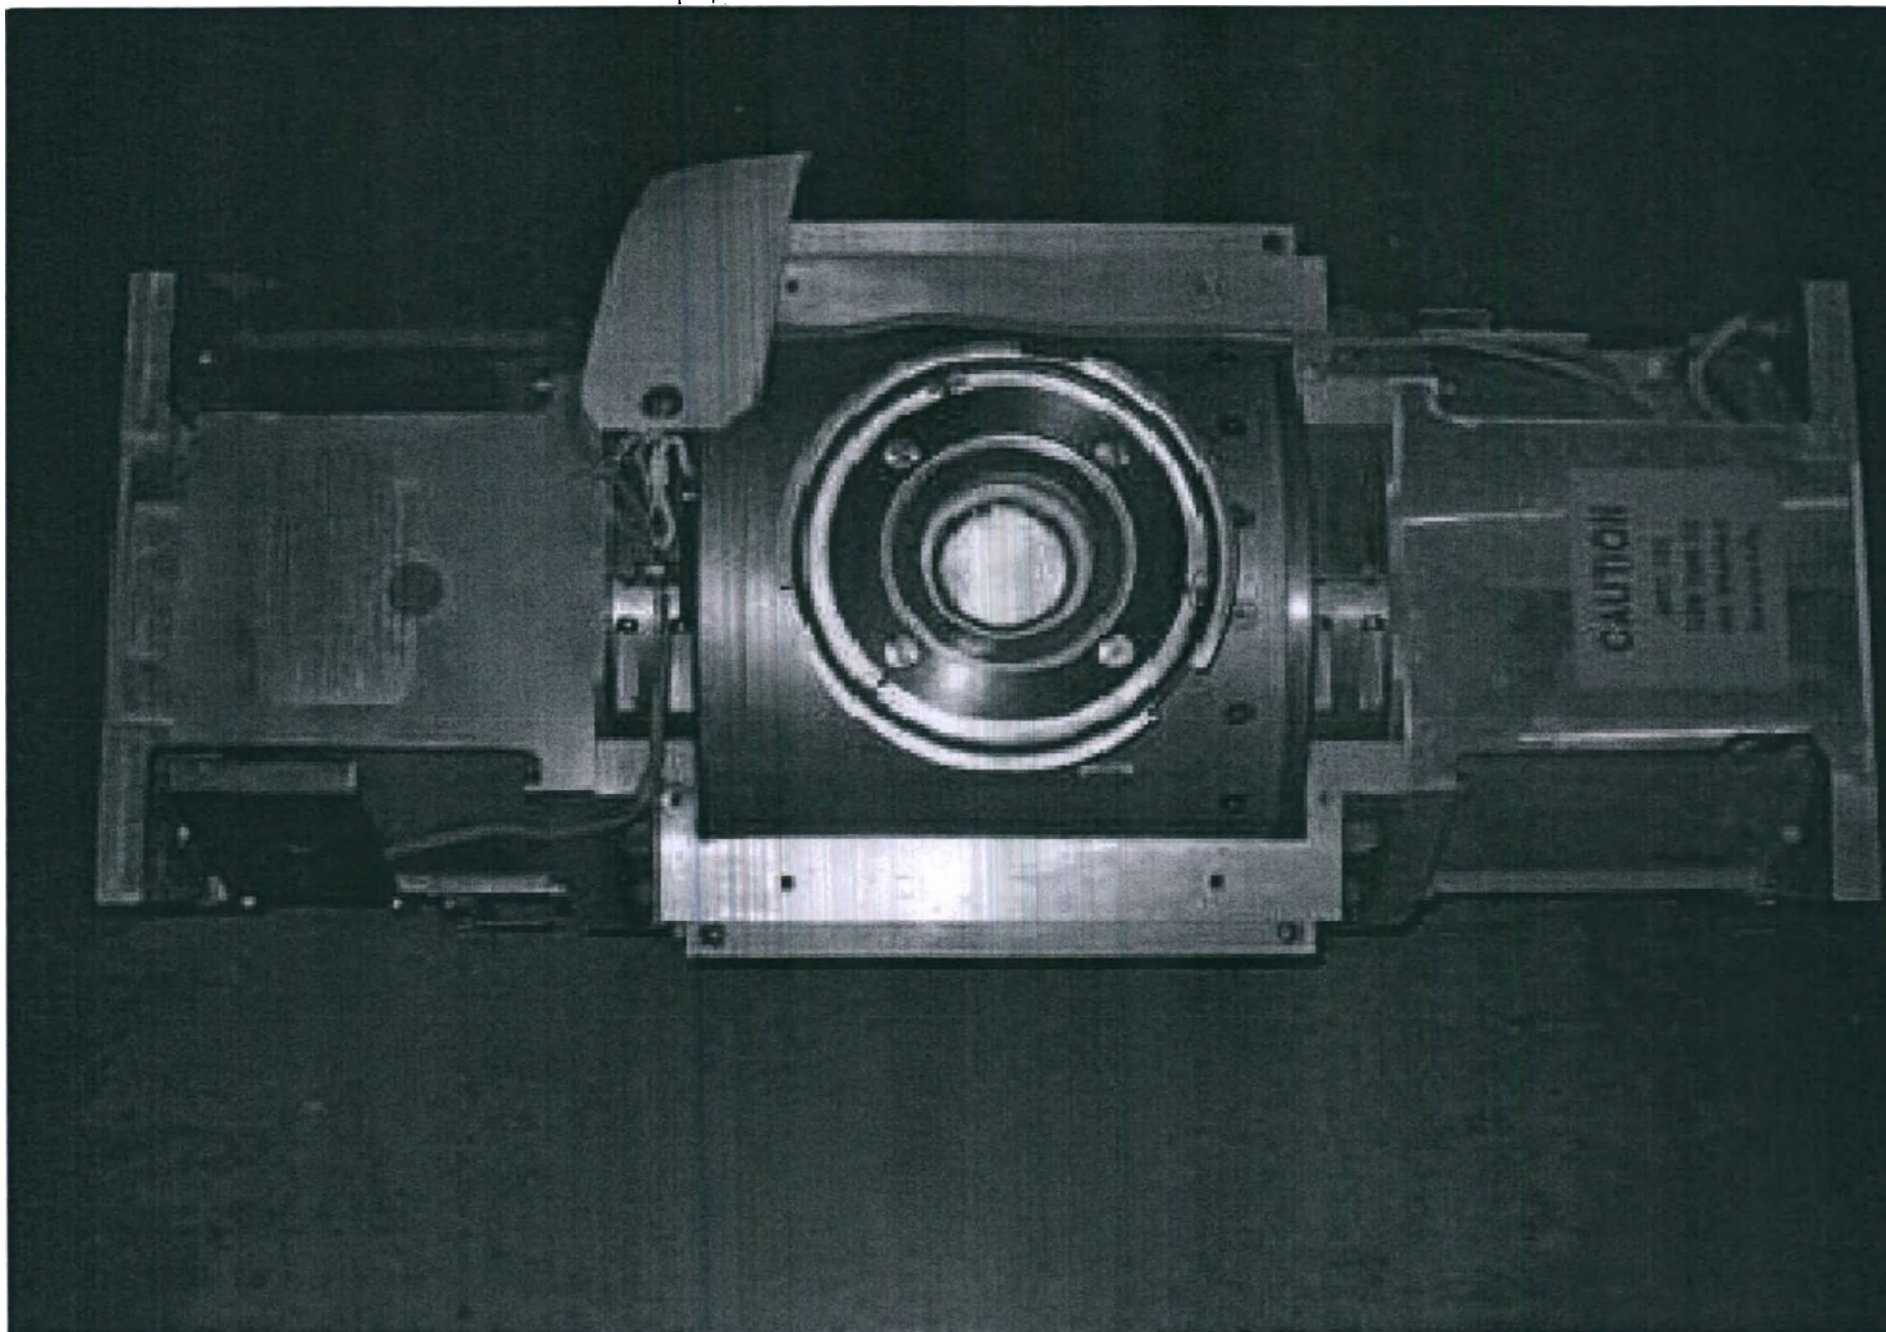


2.г. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C15.

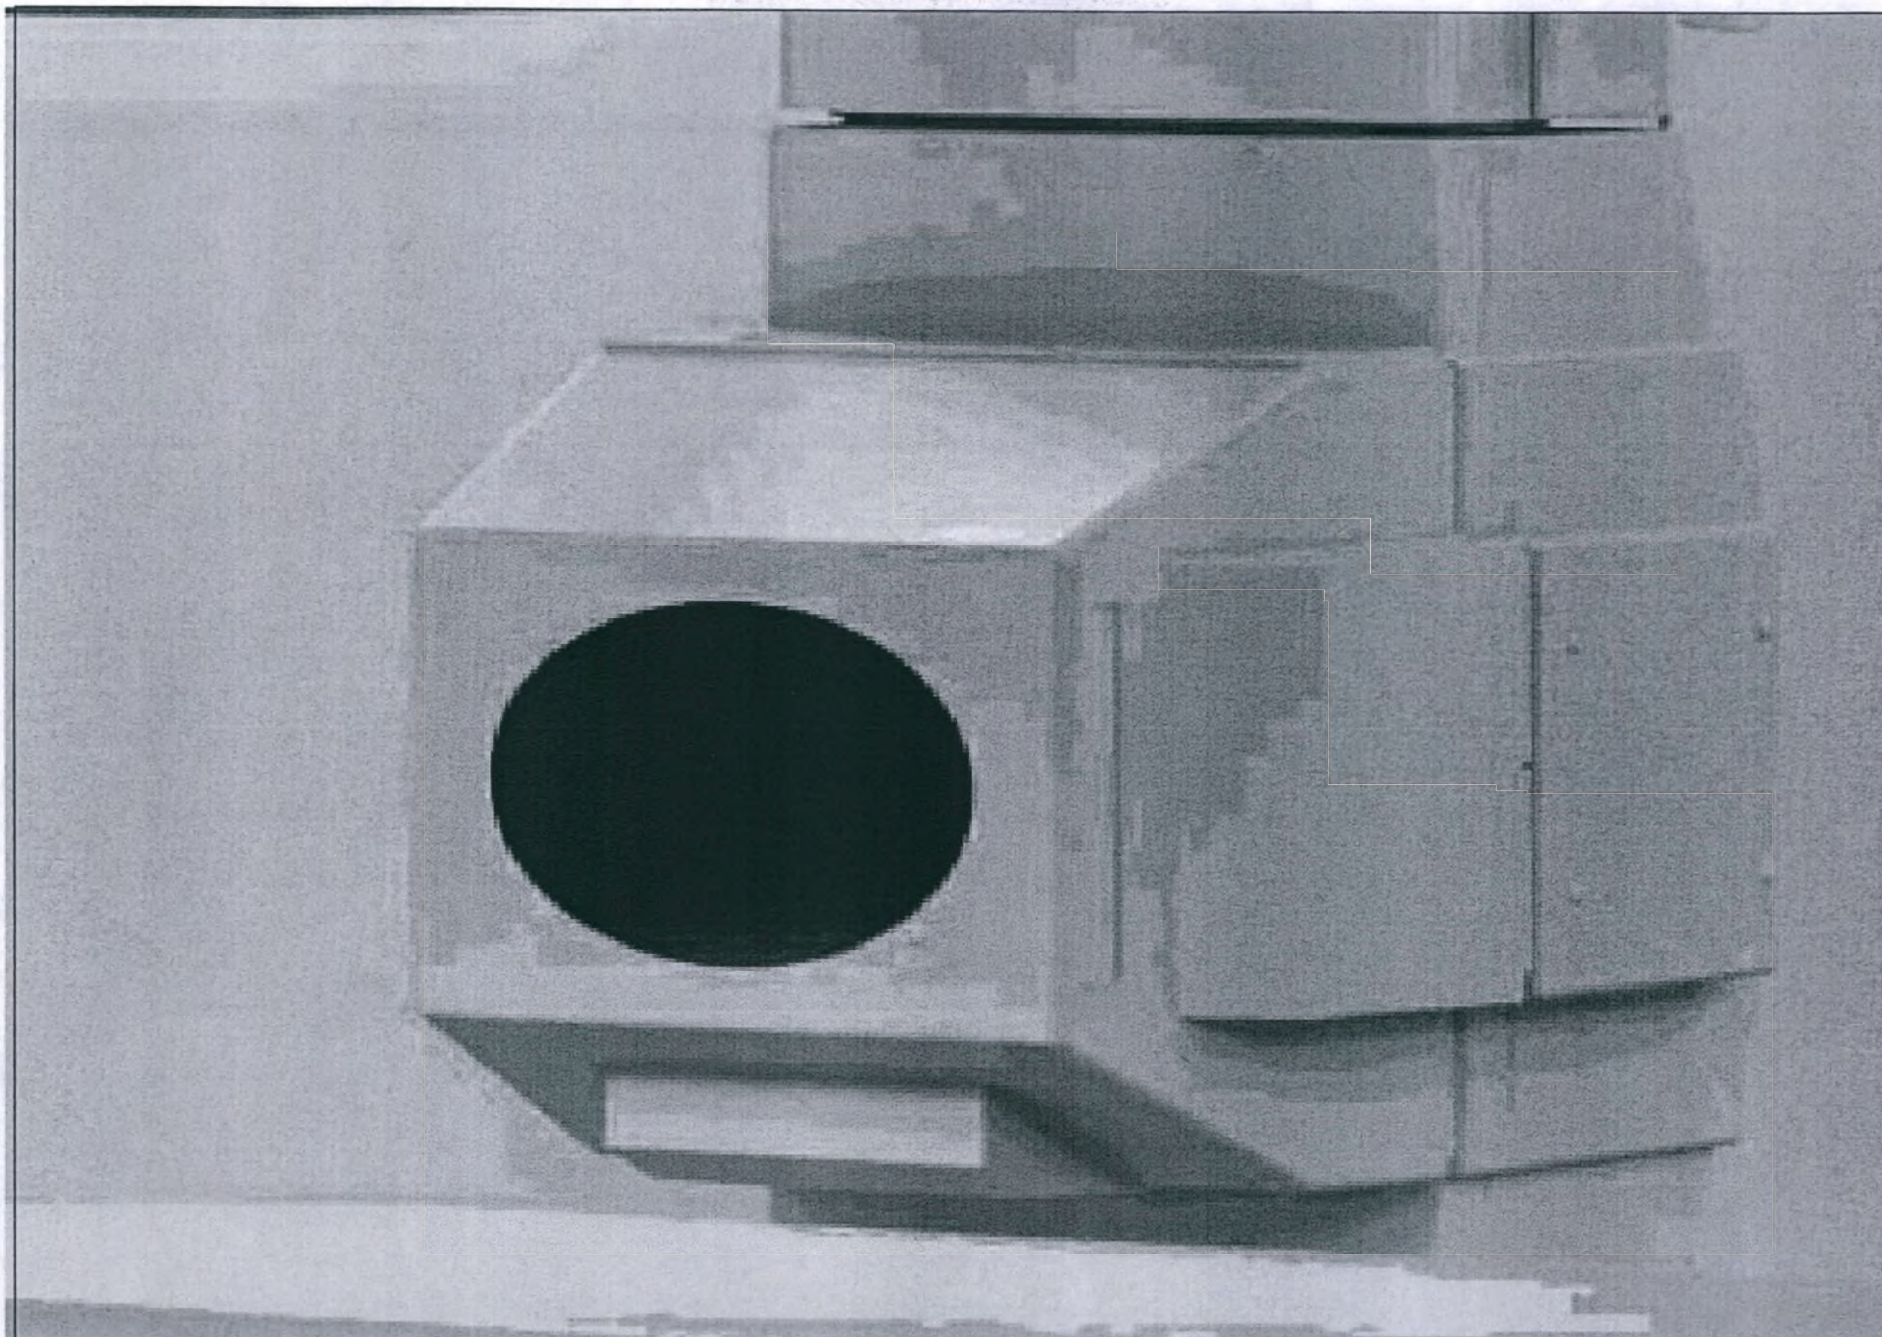


2.д. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С15.

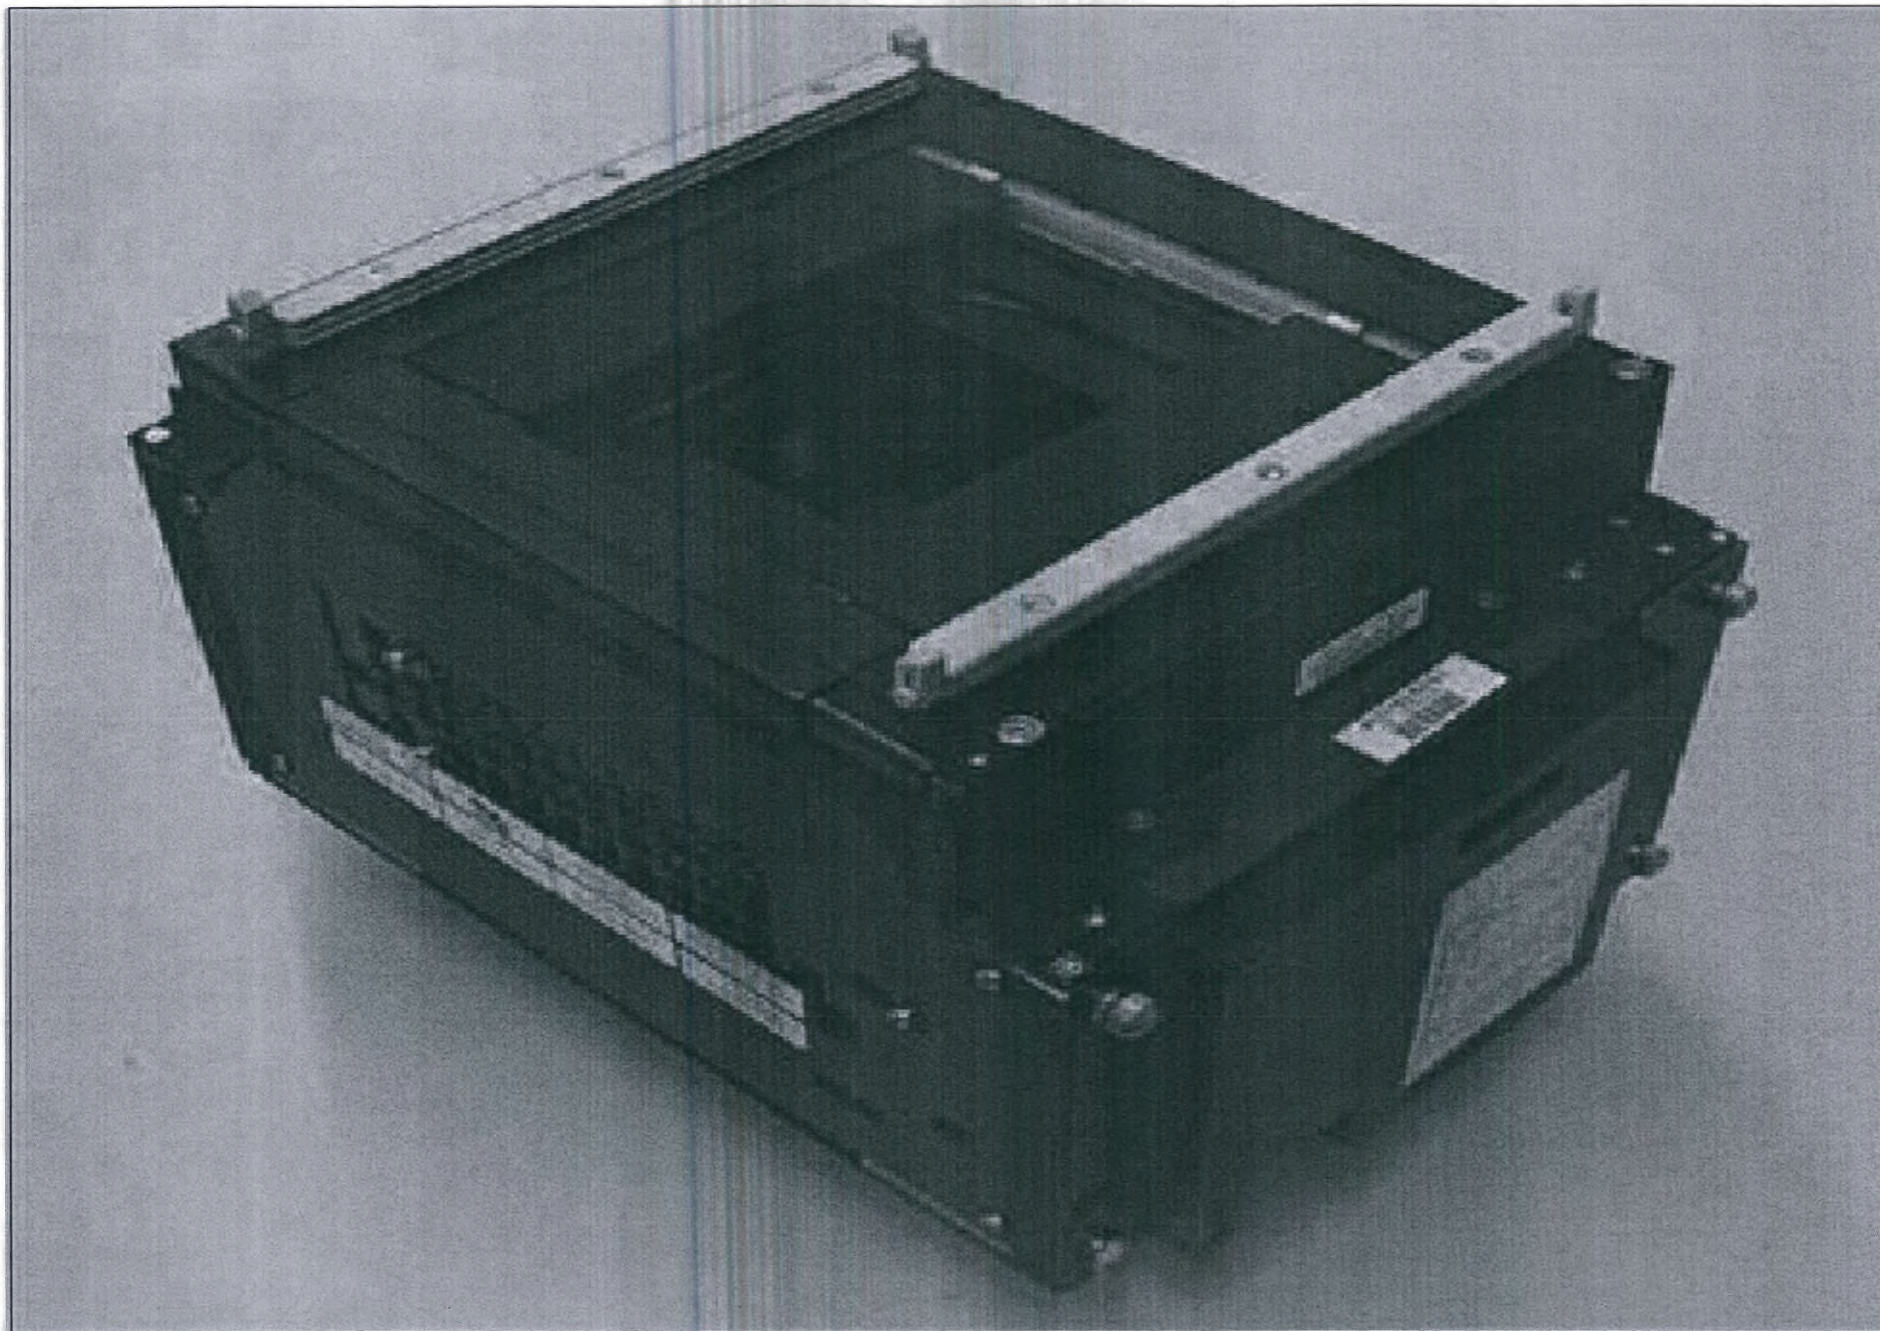


2.е. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С15.

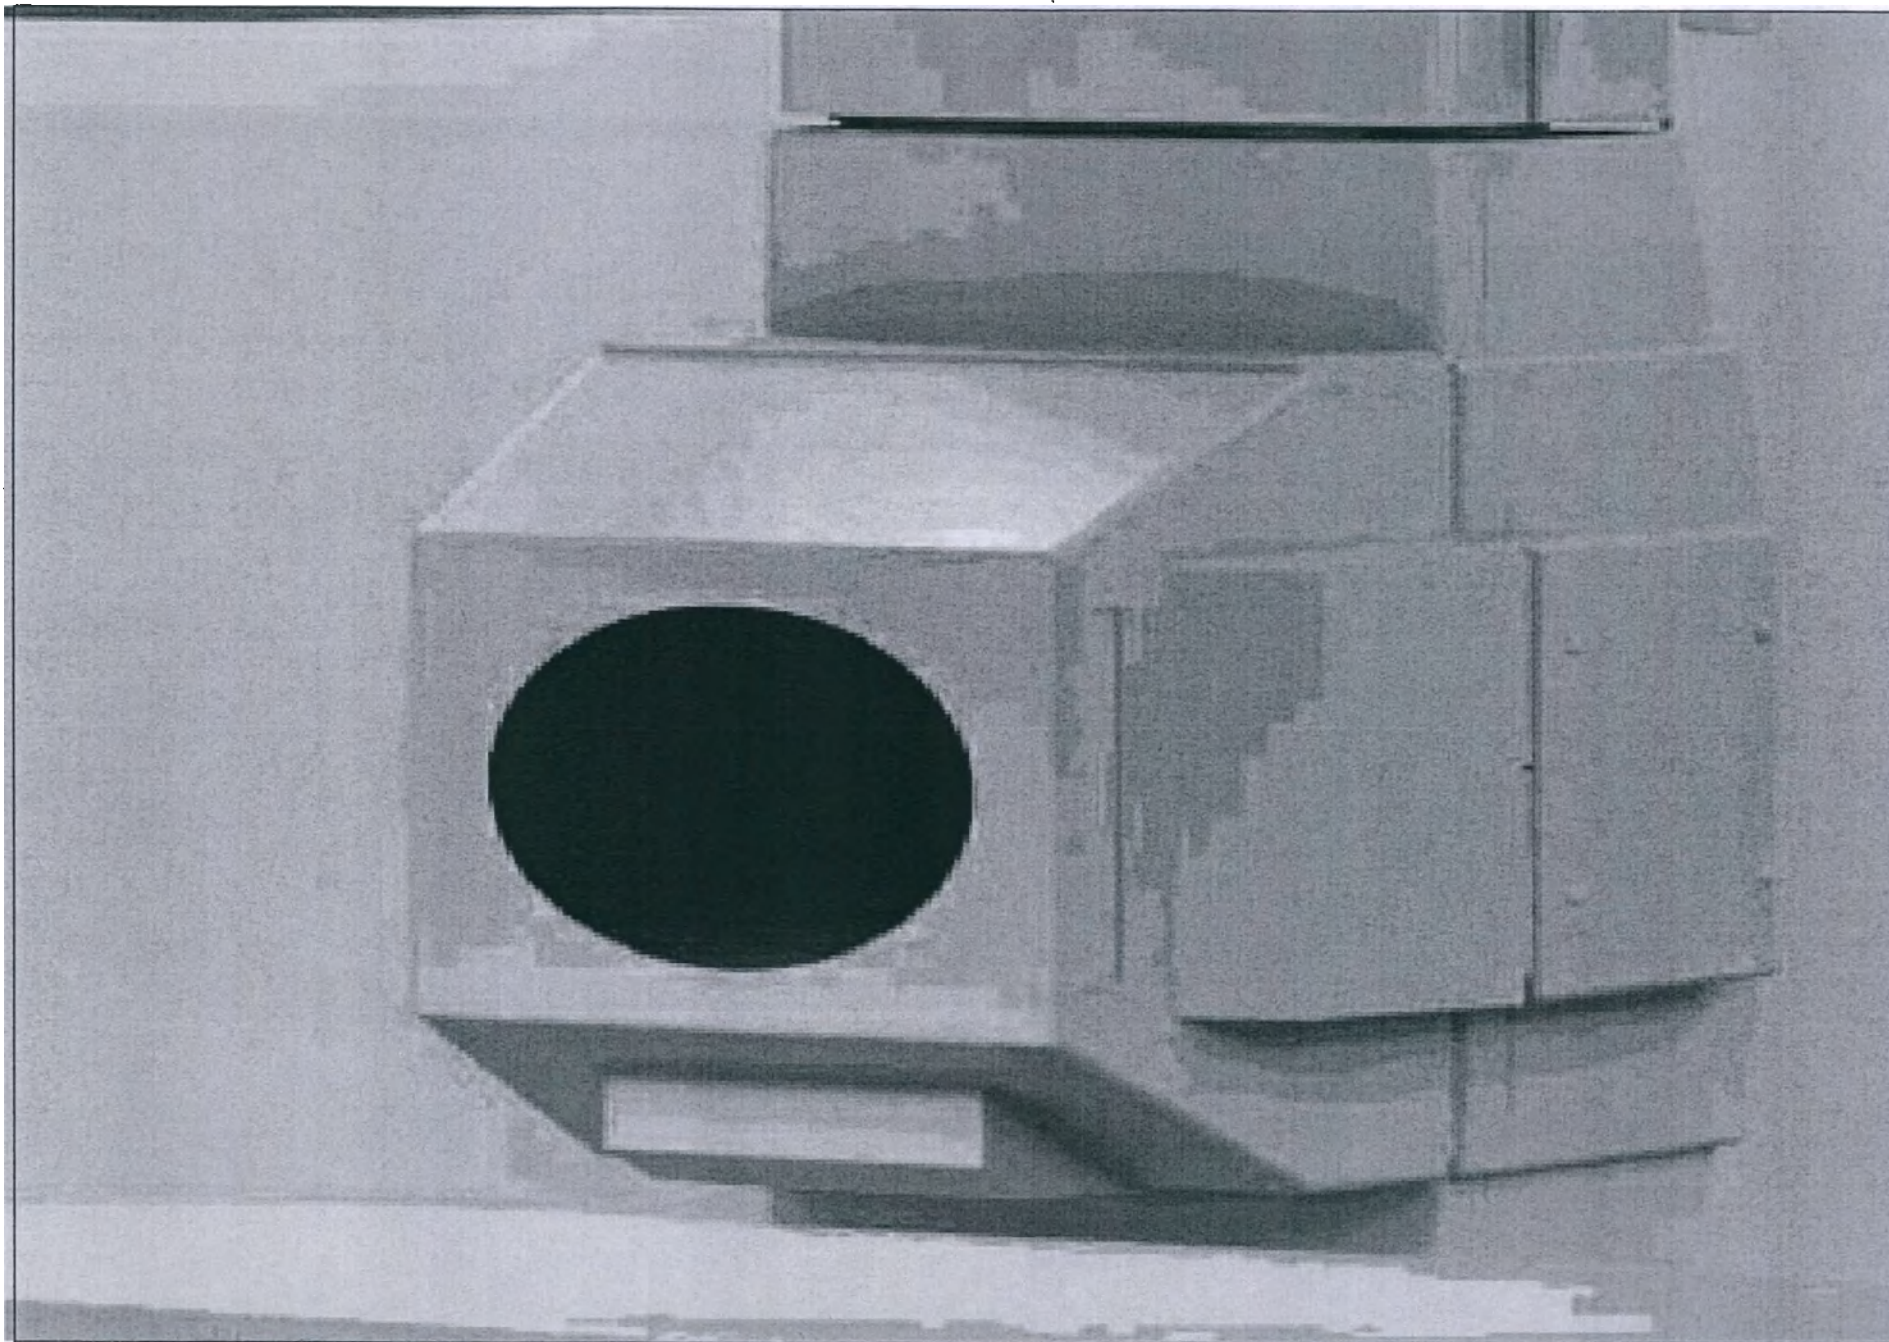


2.ж. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С15.

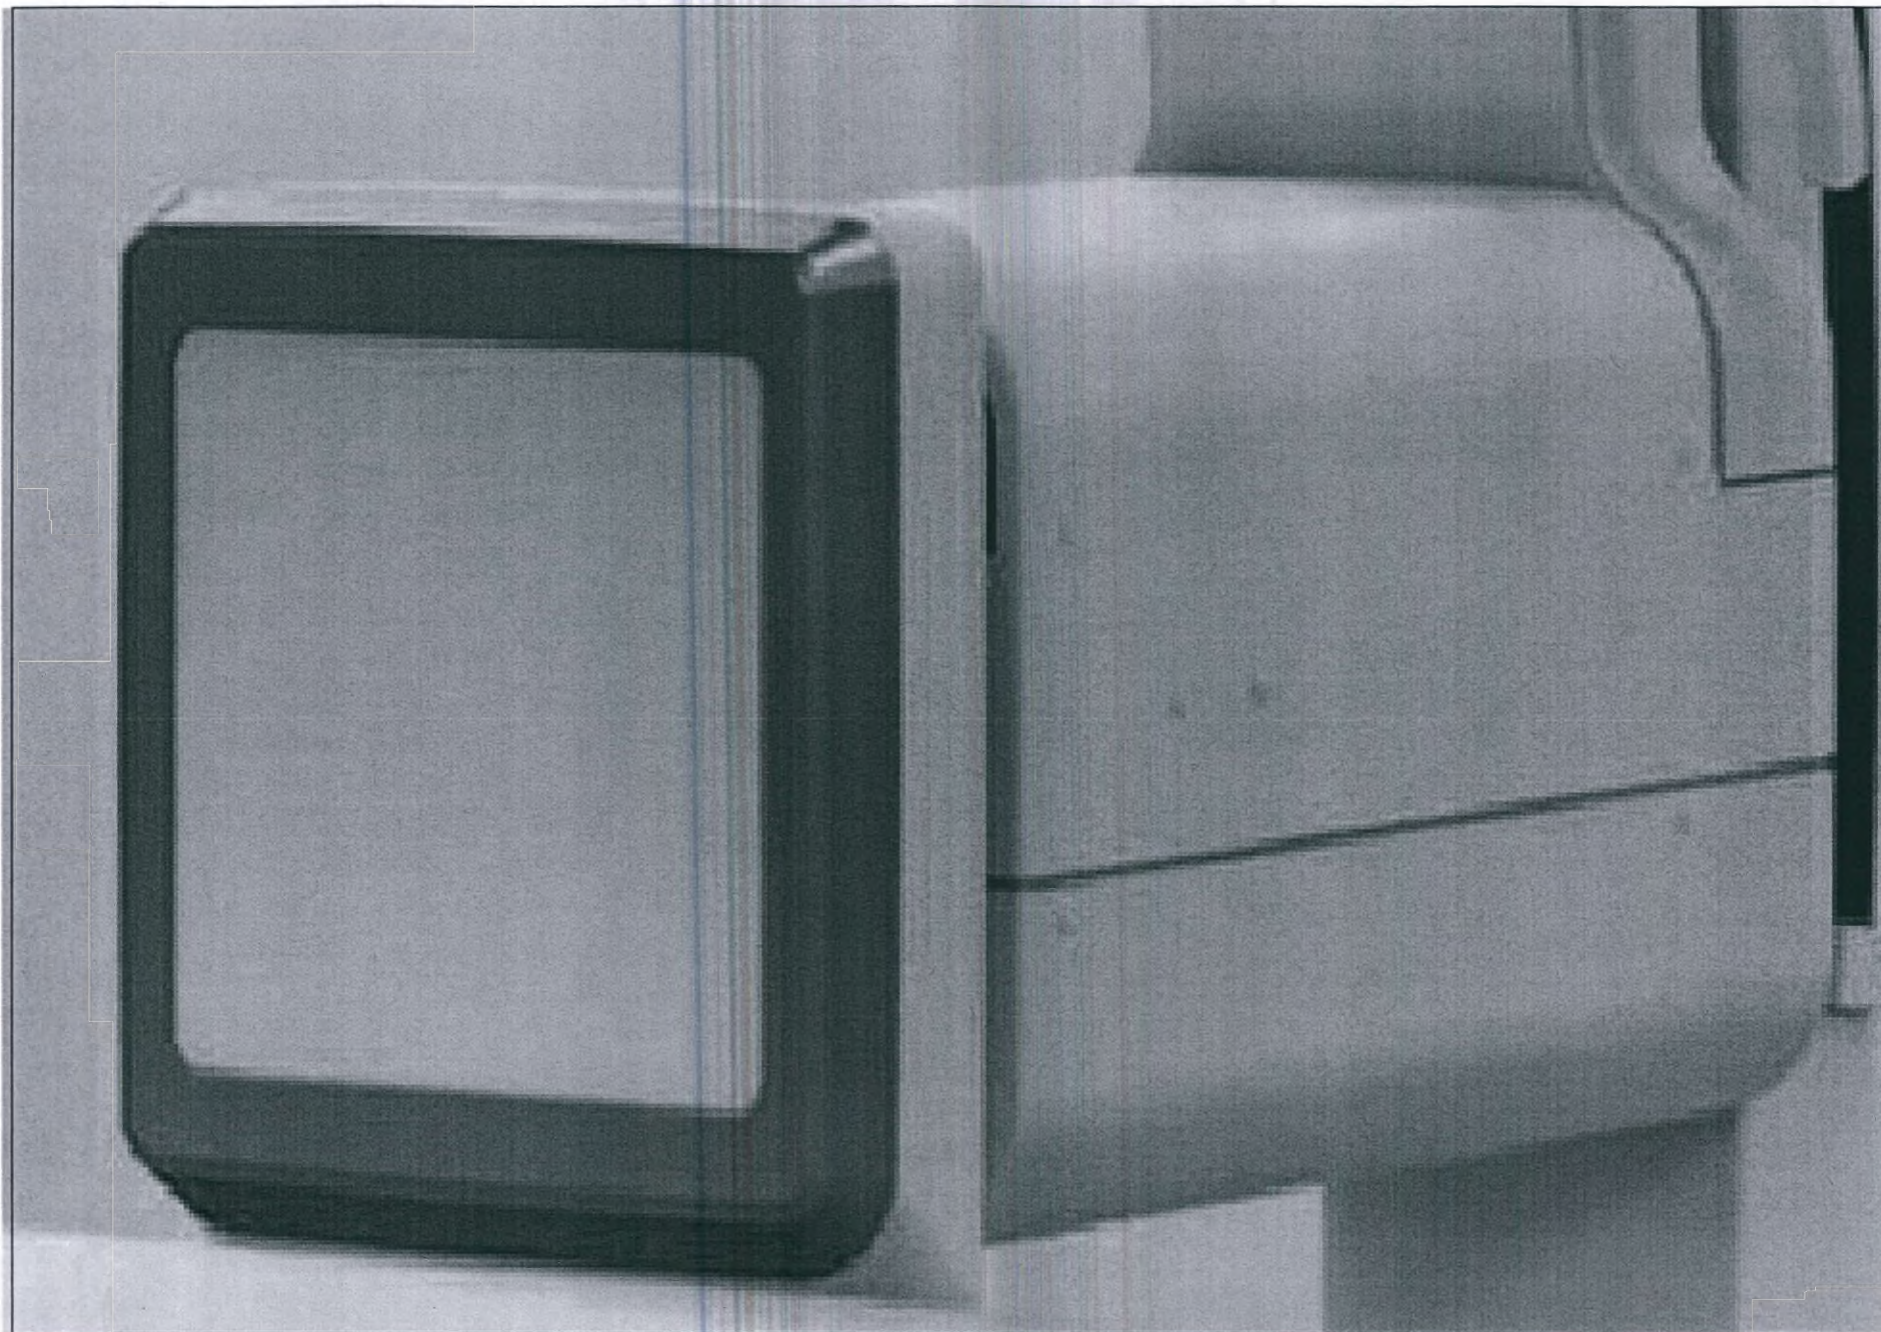


2.3. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C15.

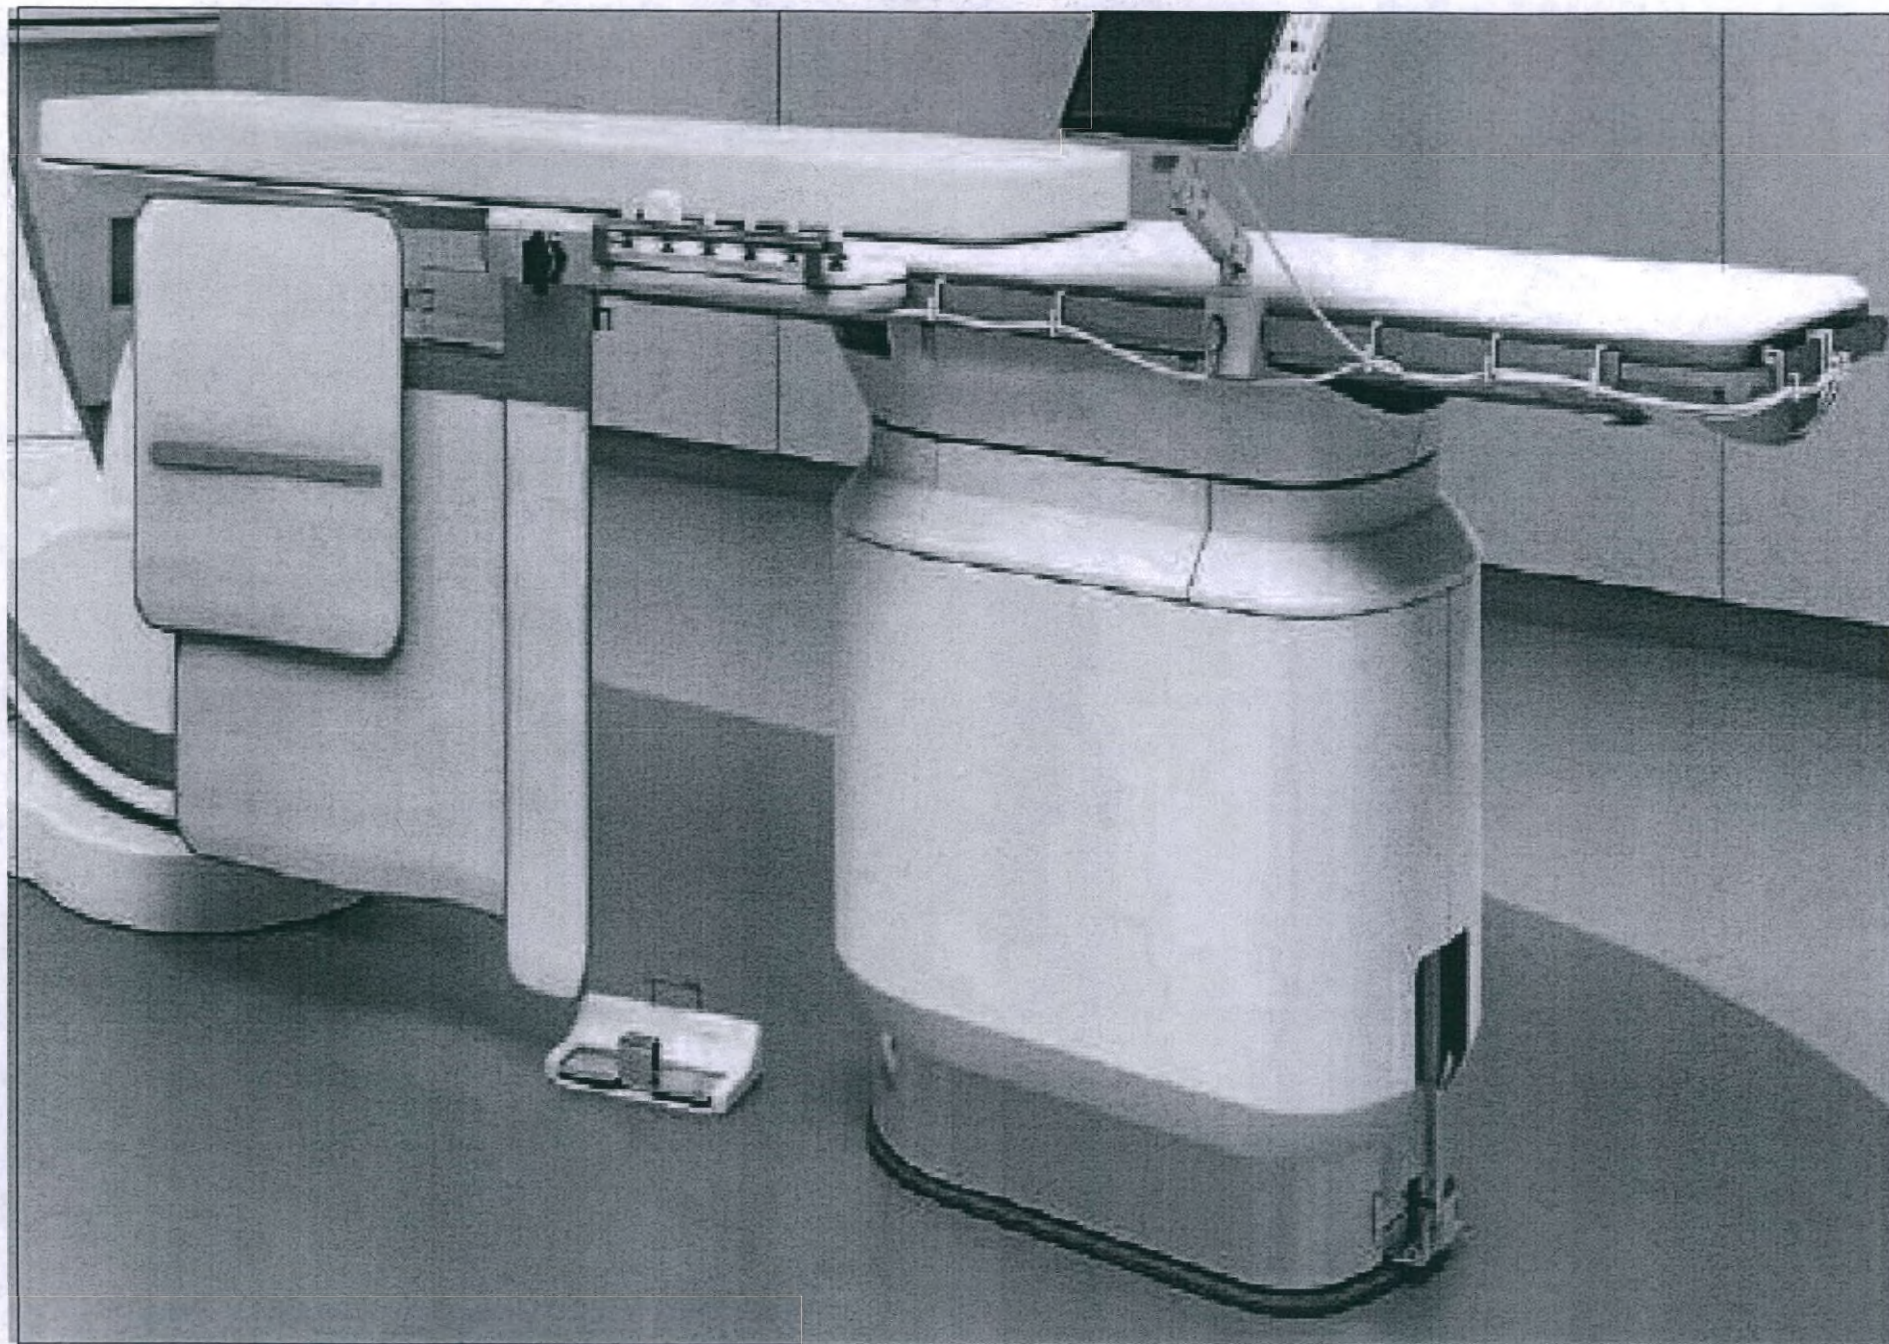


3.а. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

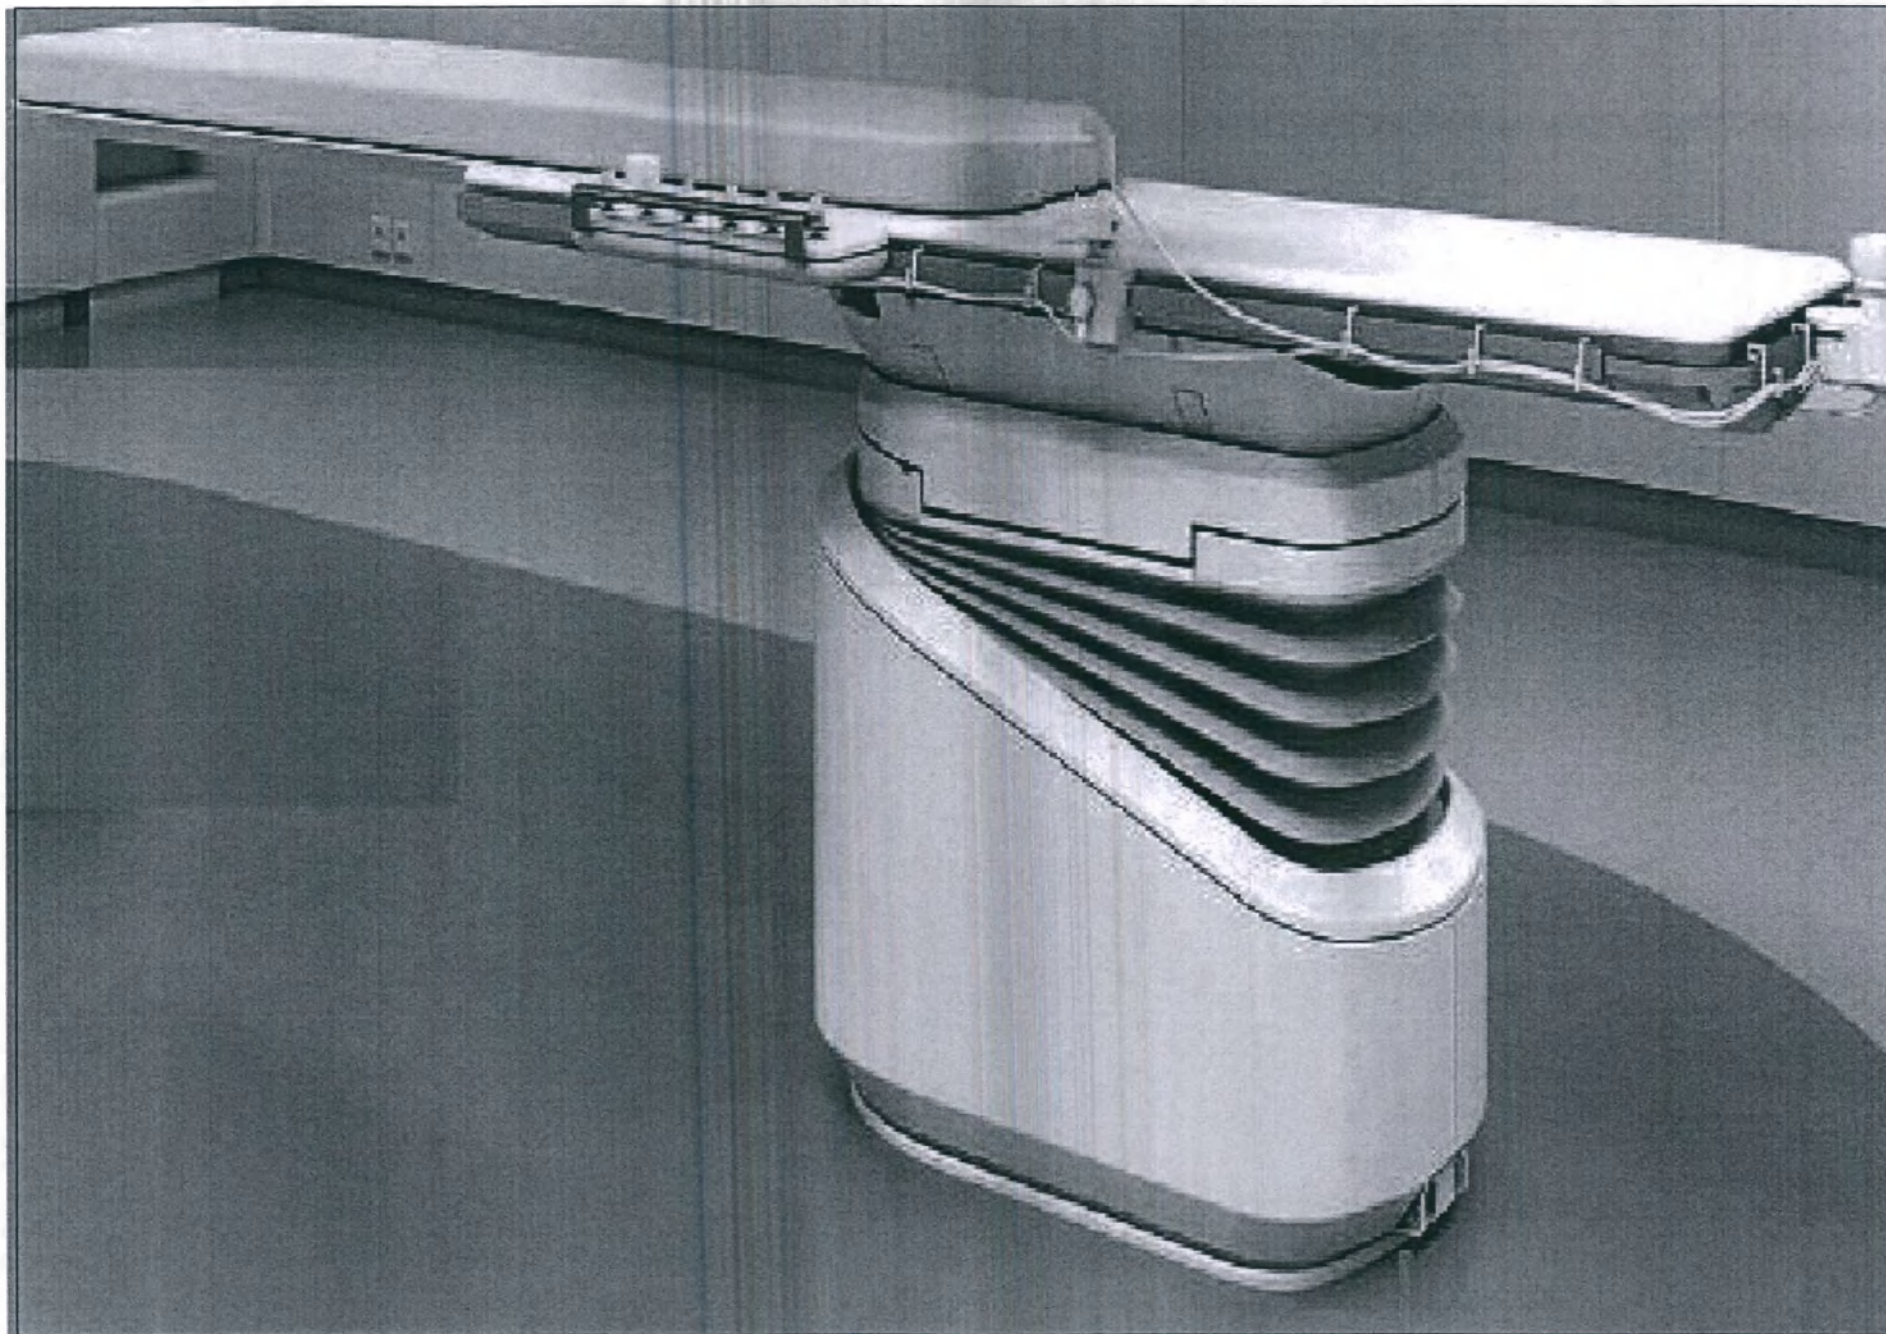

3.6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

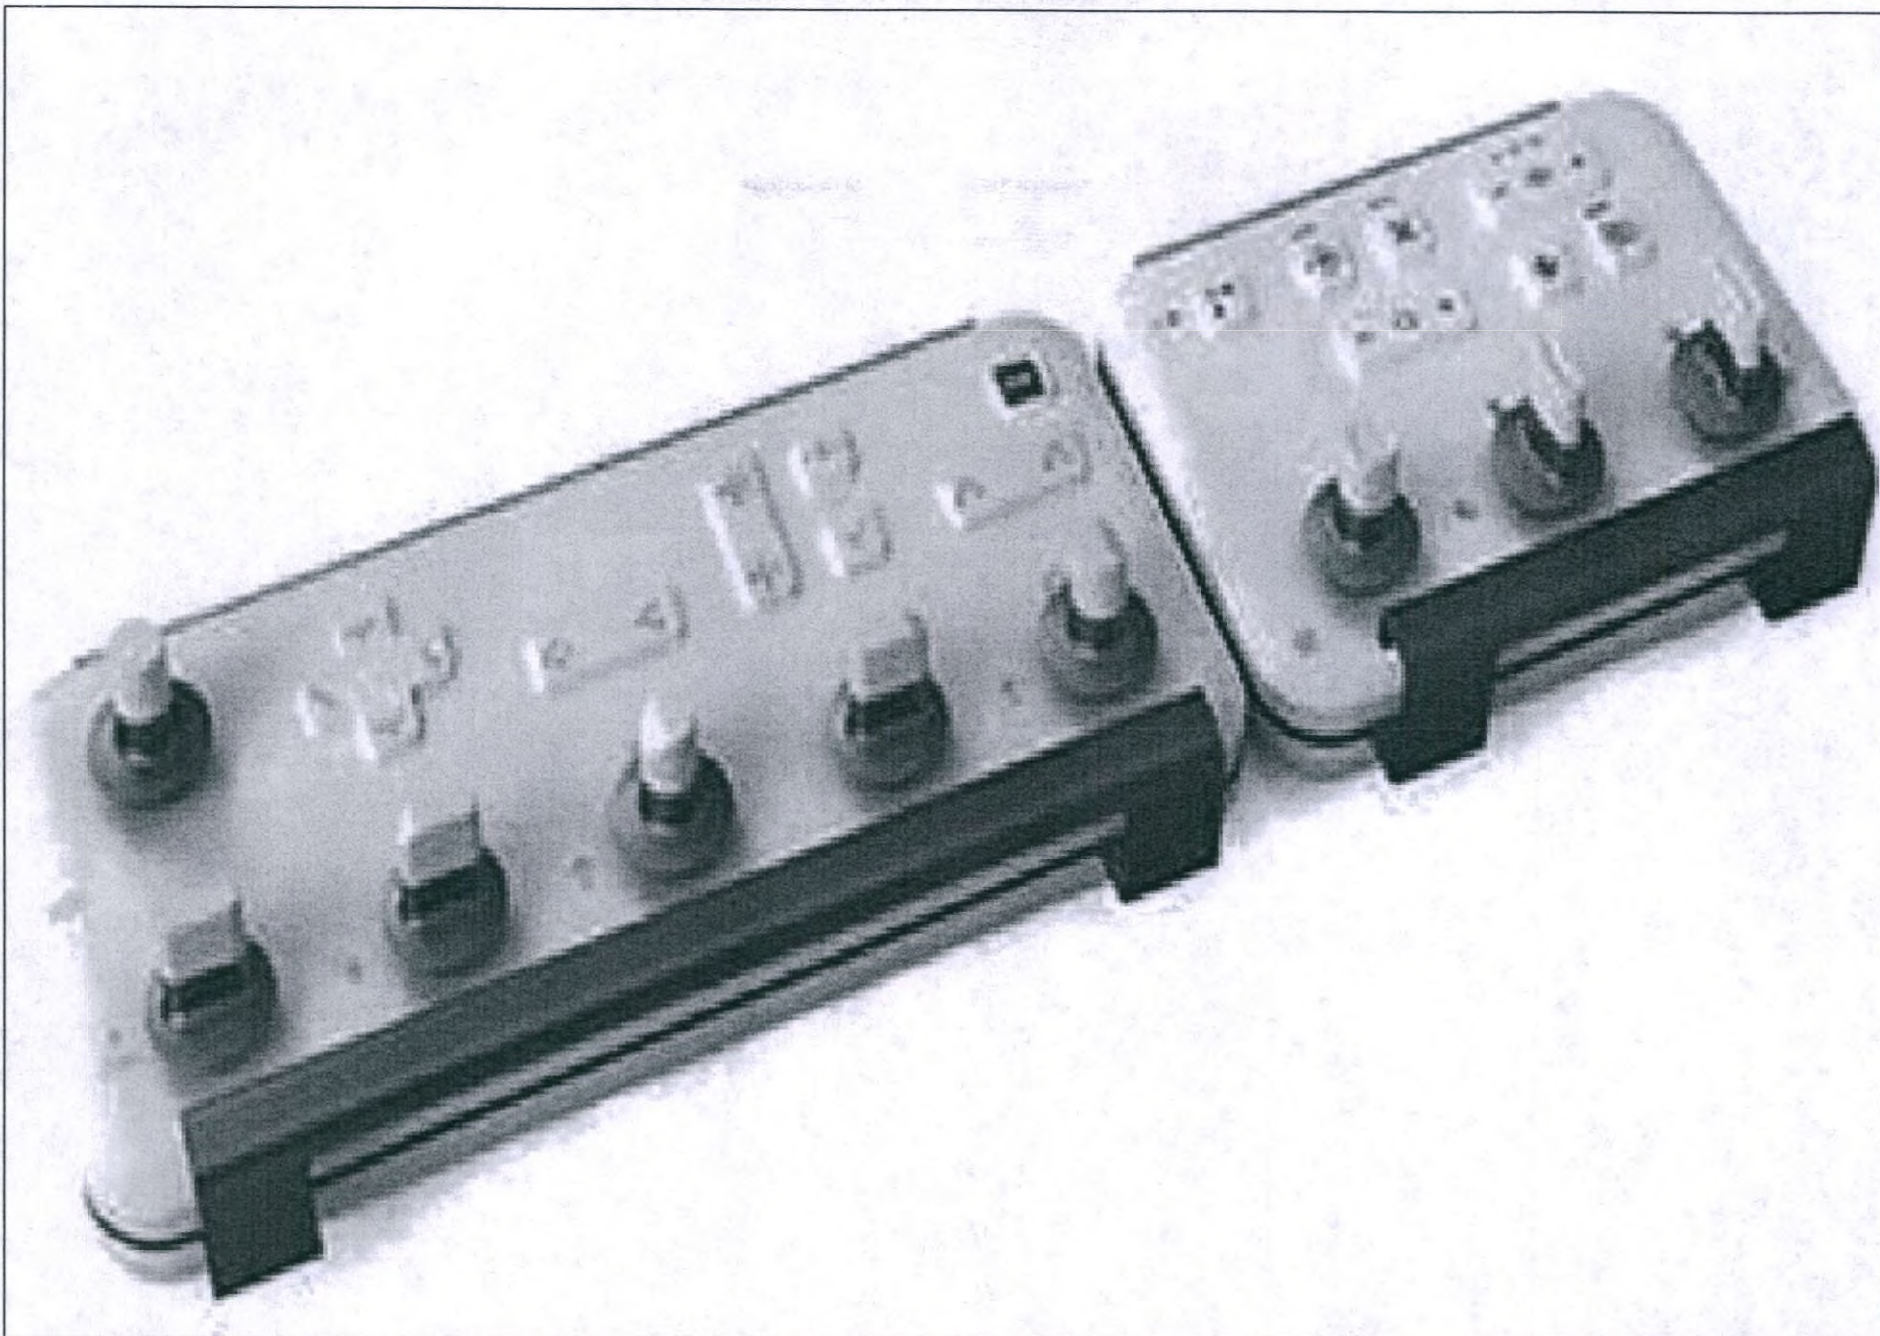


4. Модуль управления, не более 4 шт.

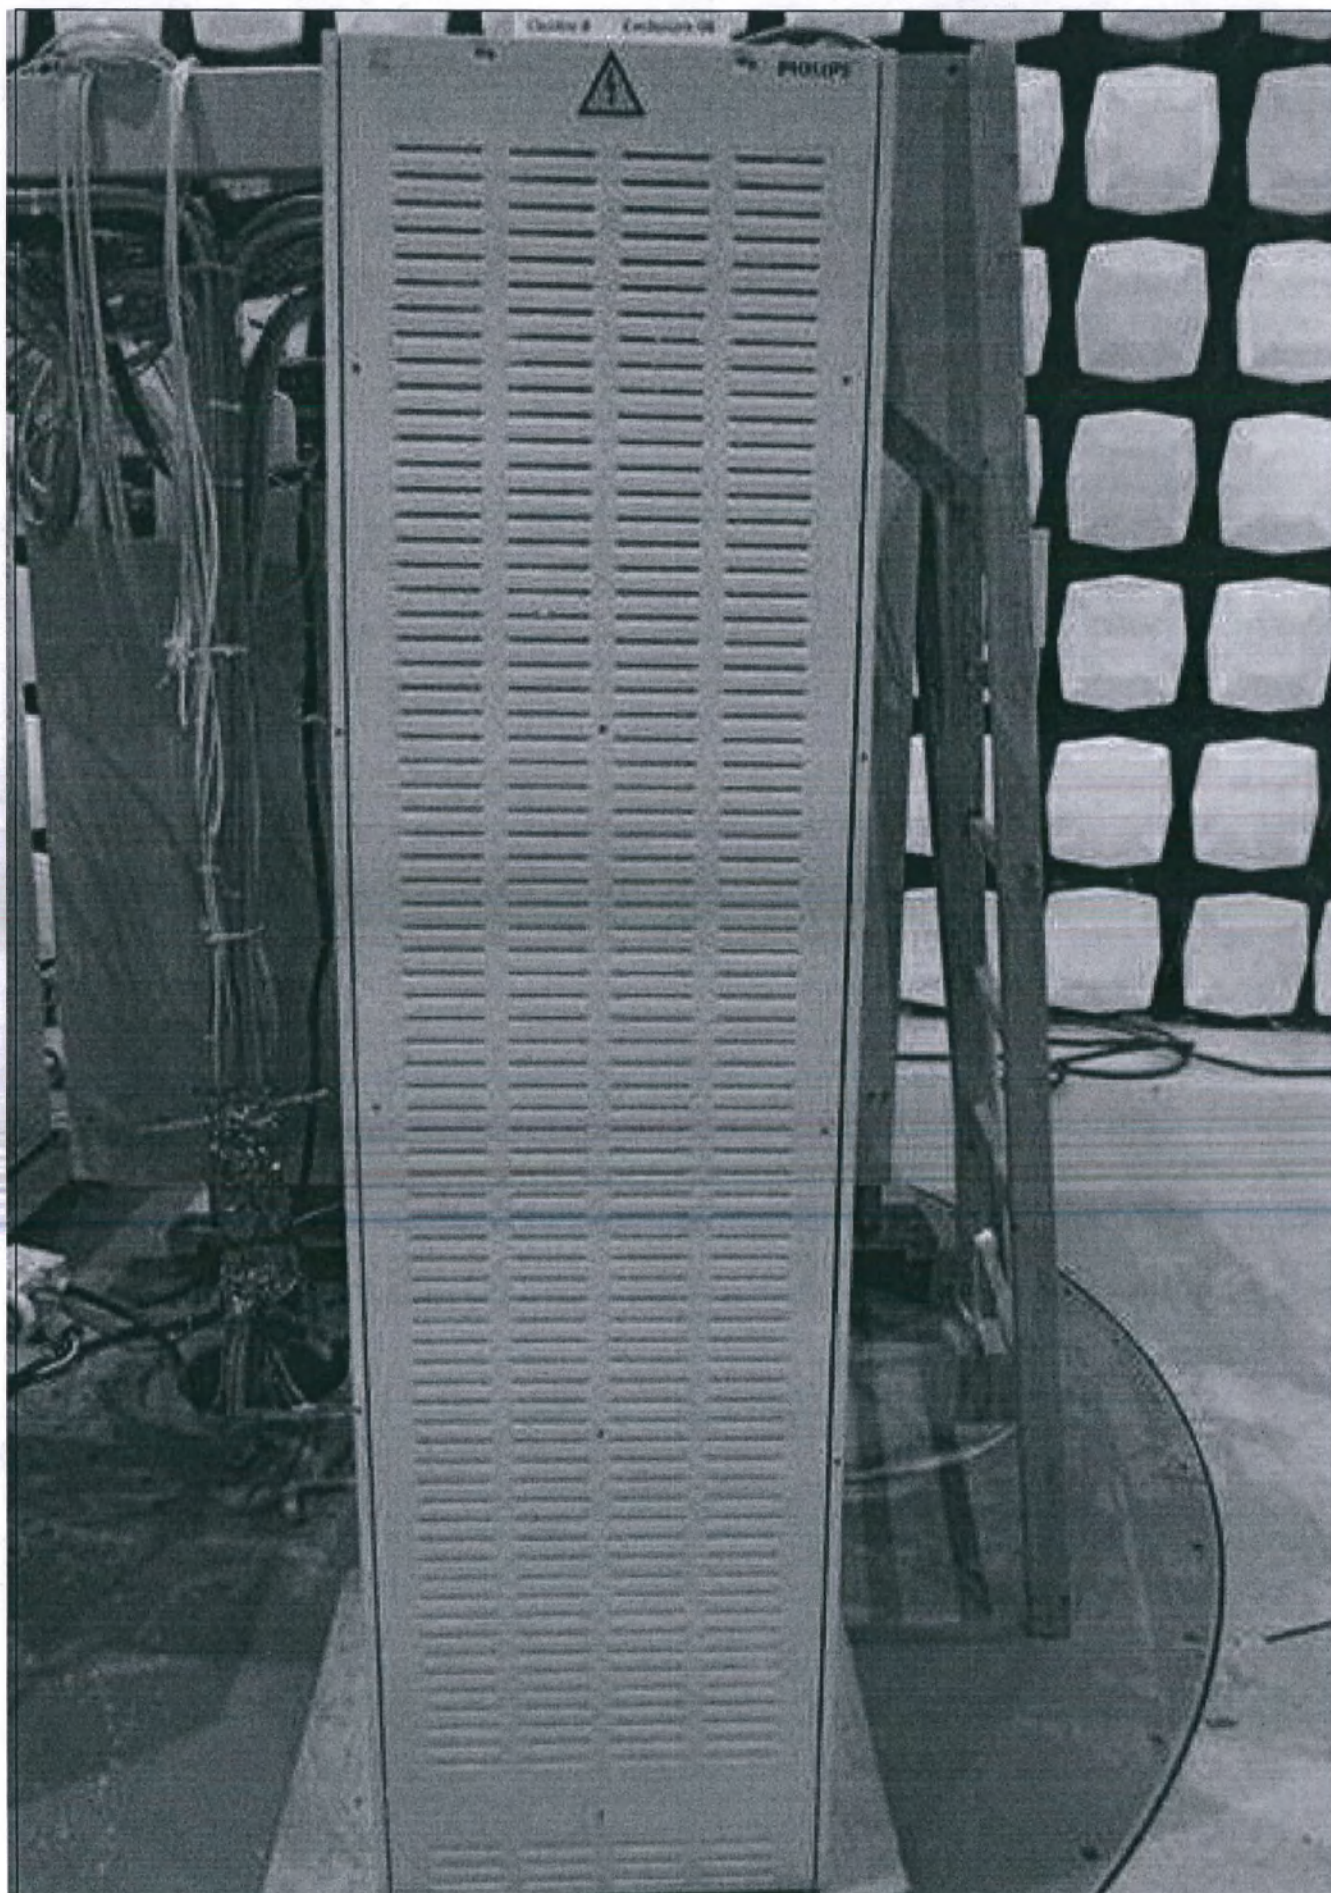

5.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.





5.6. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

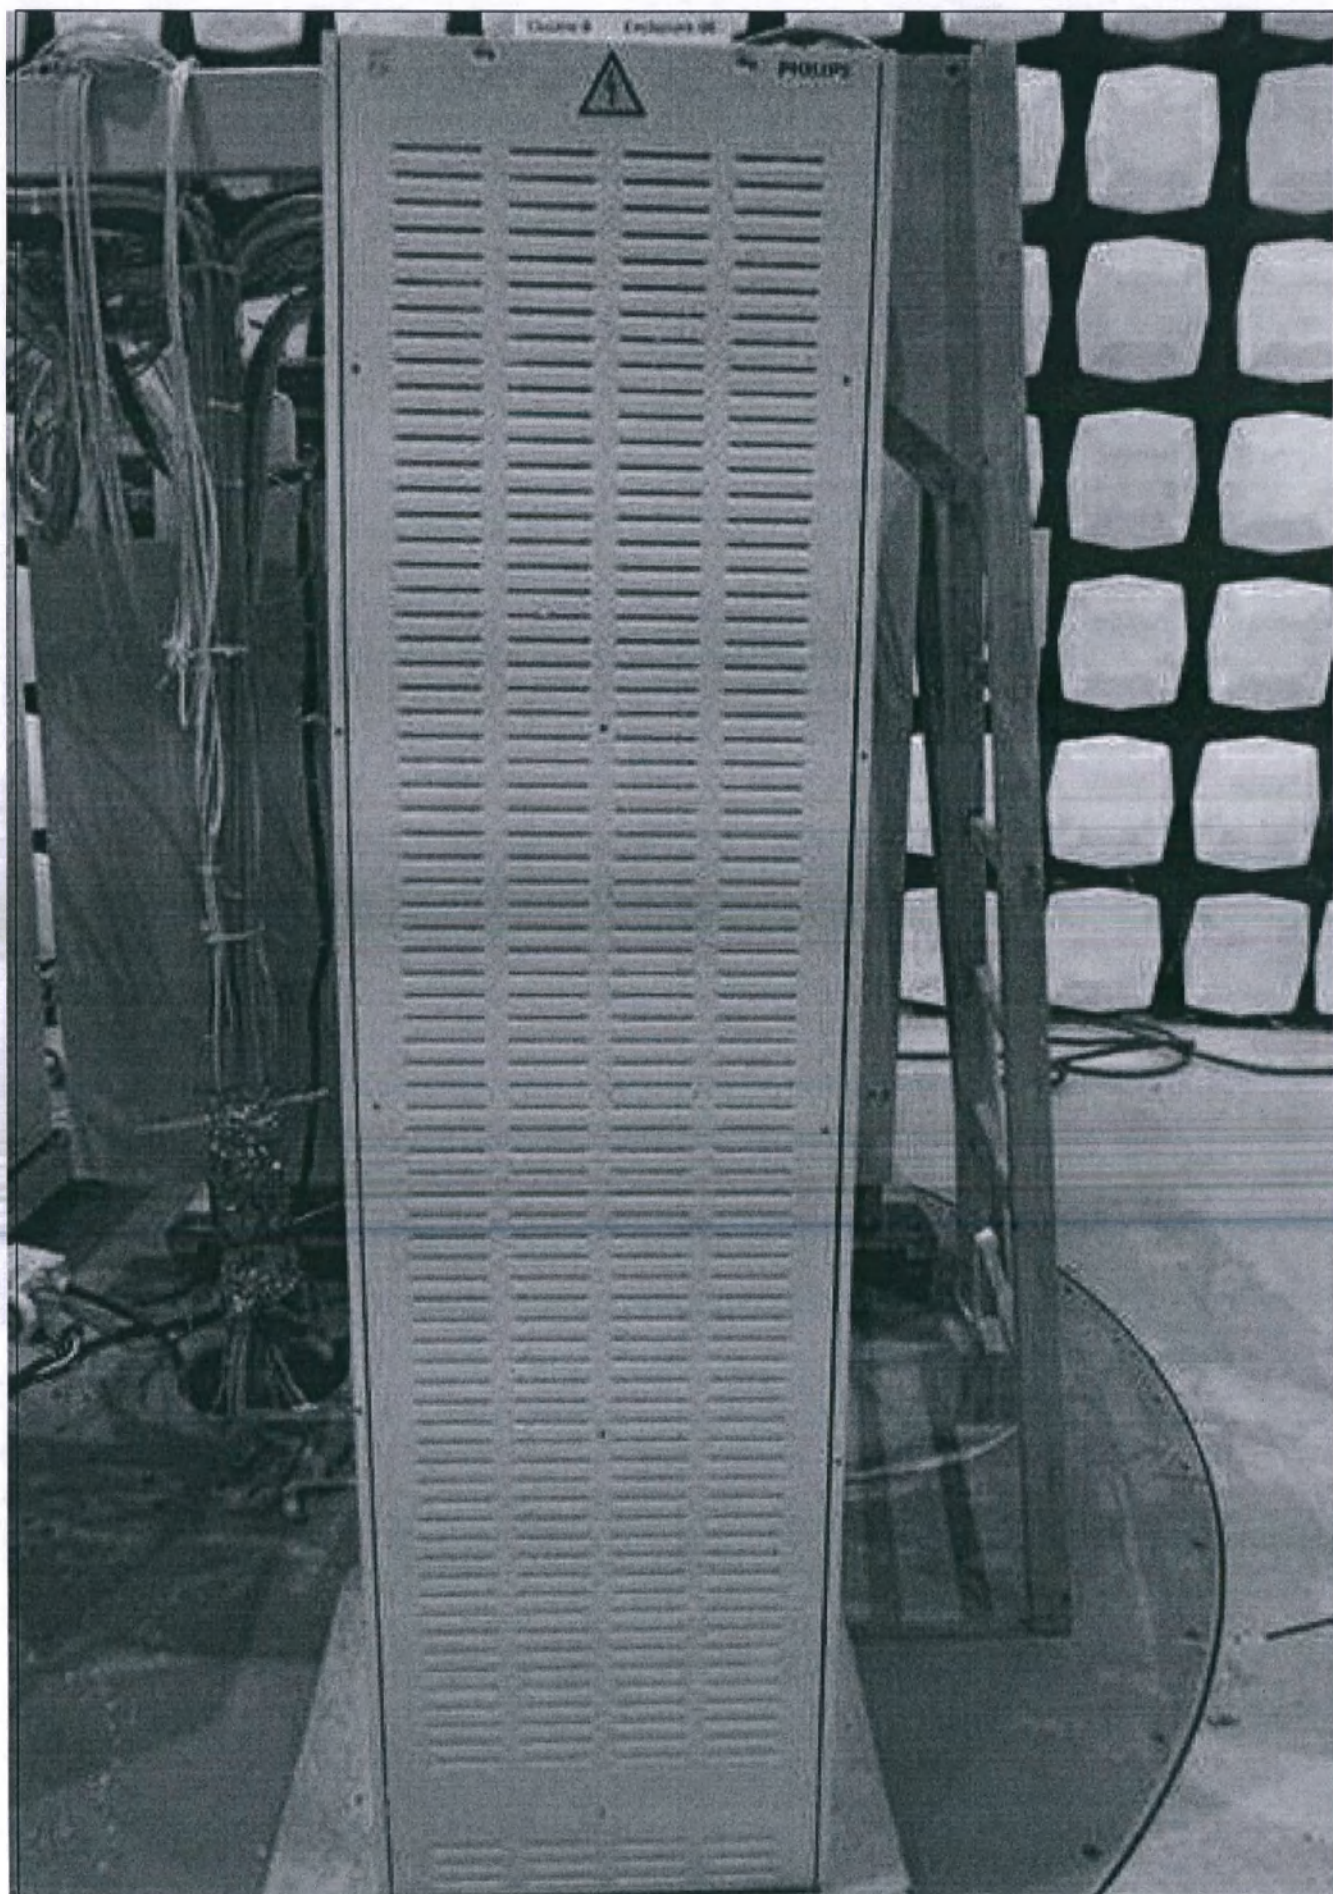


6.а. Шкаф управления.

6.6. Шкаф управления.

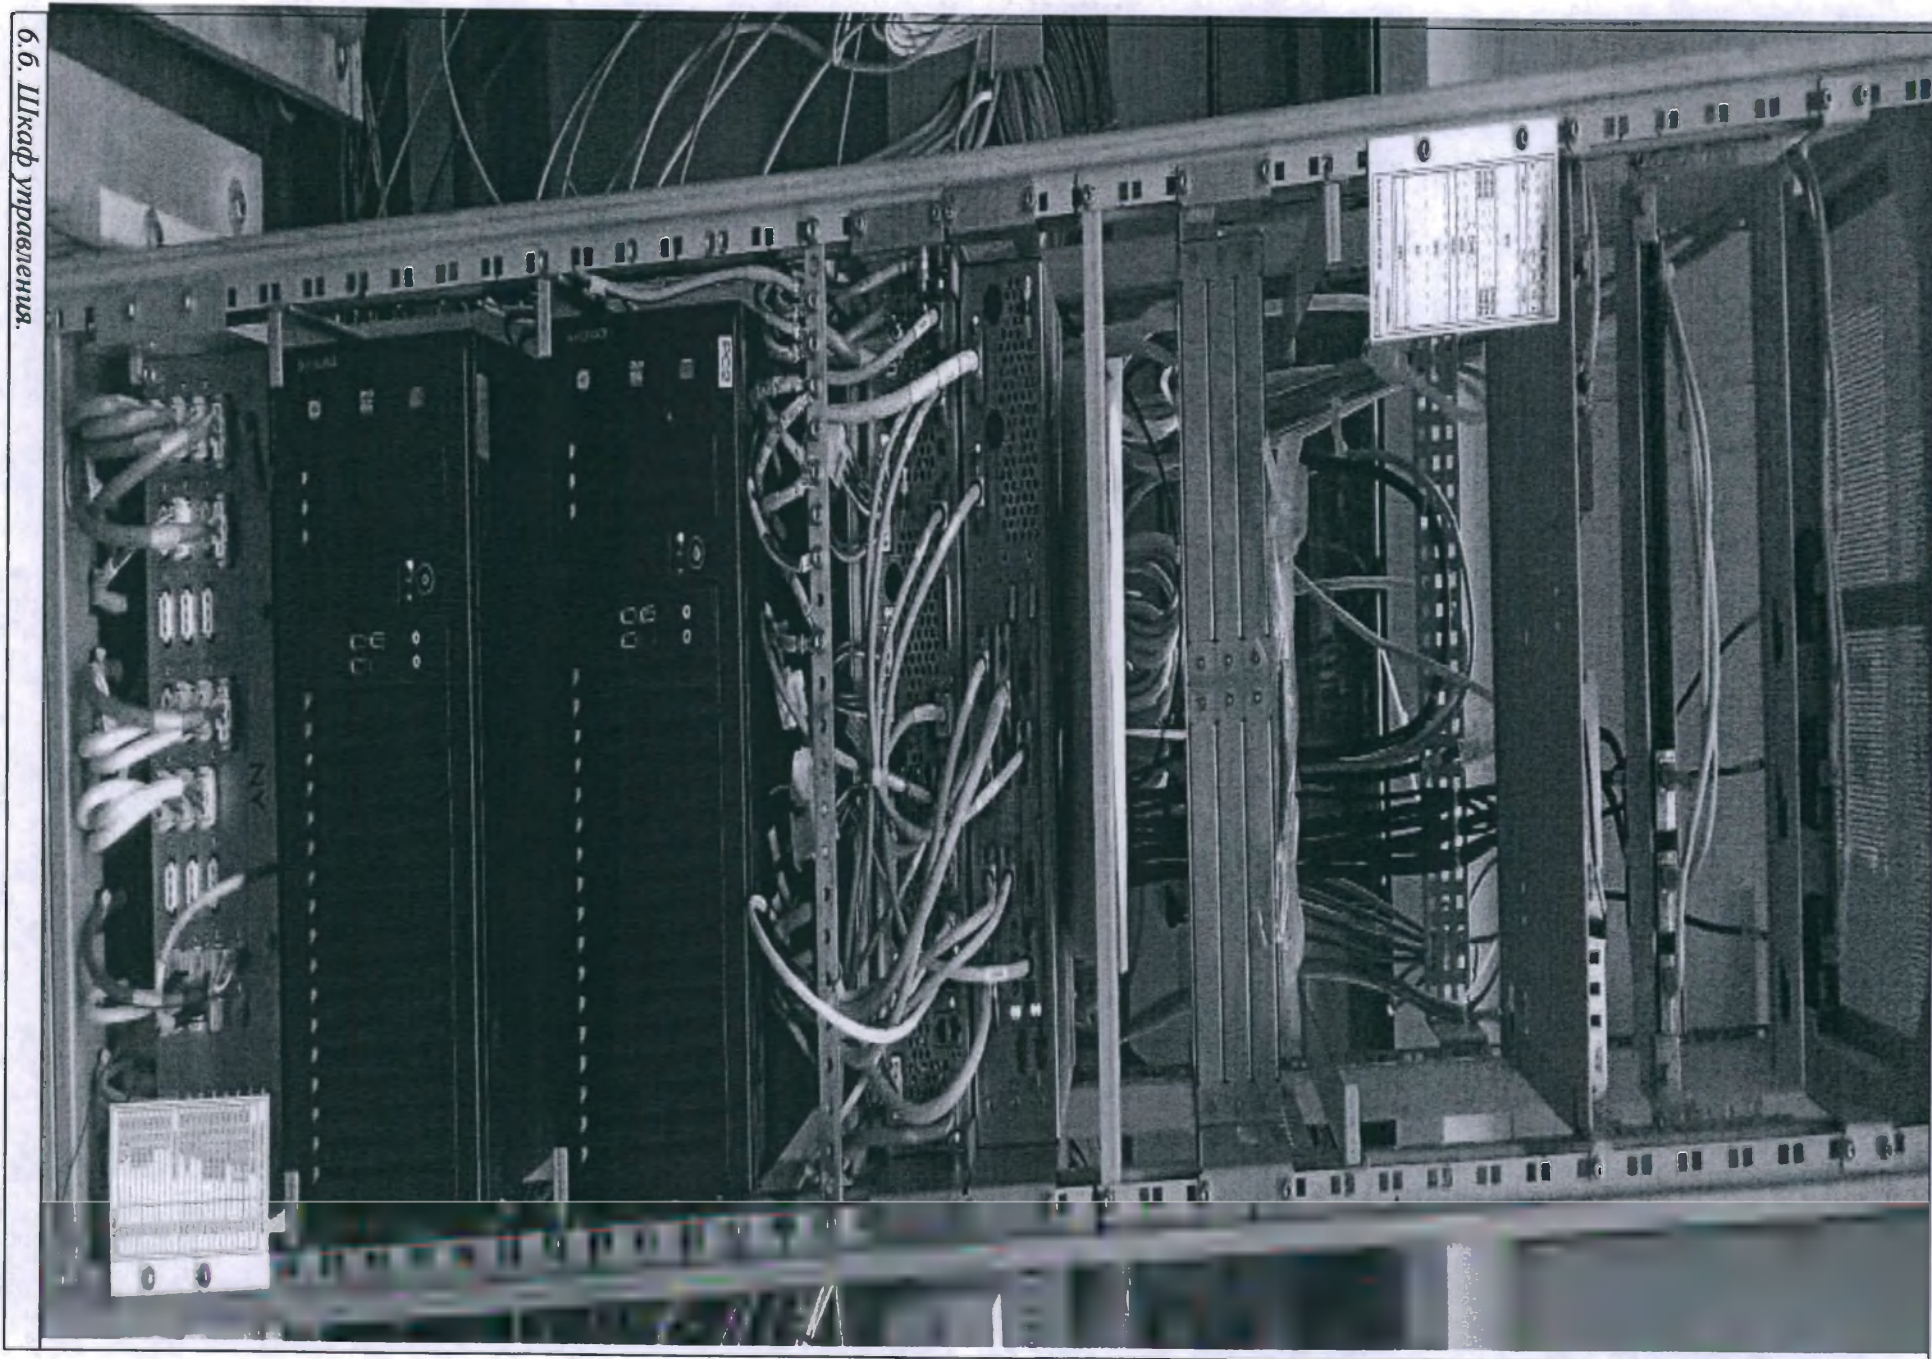

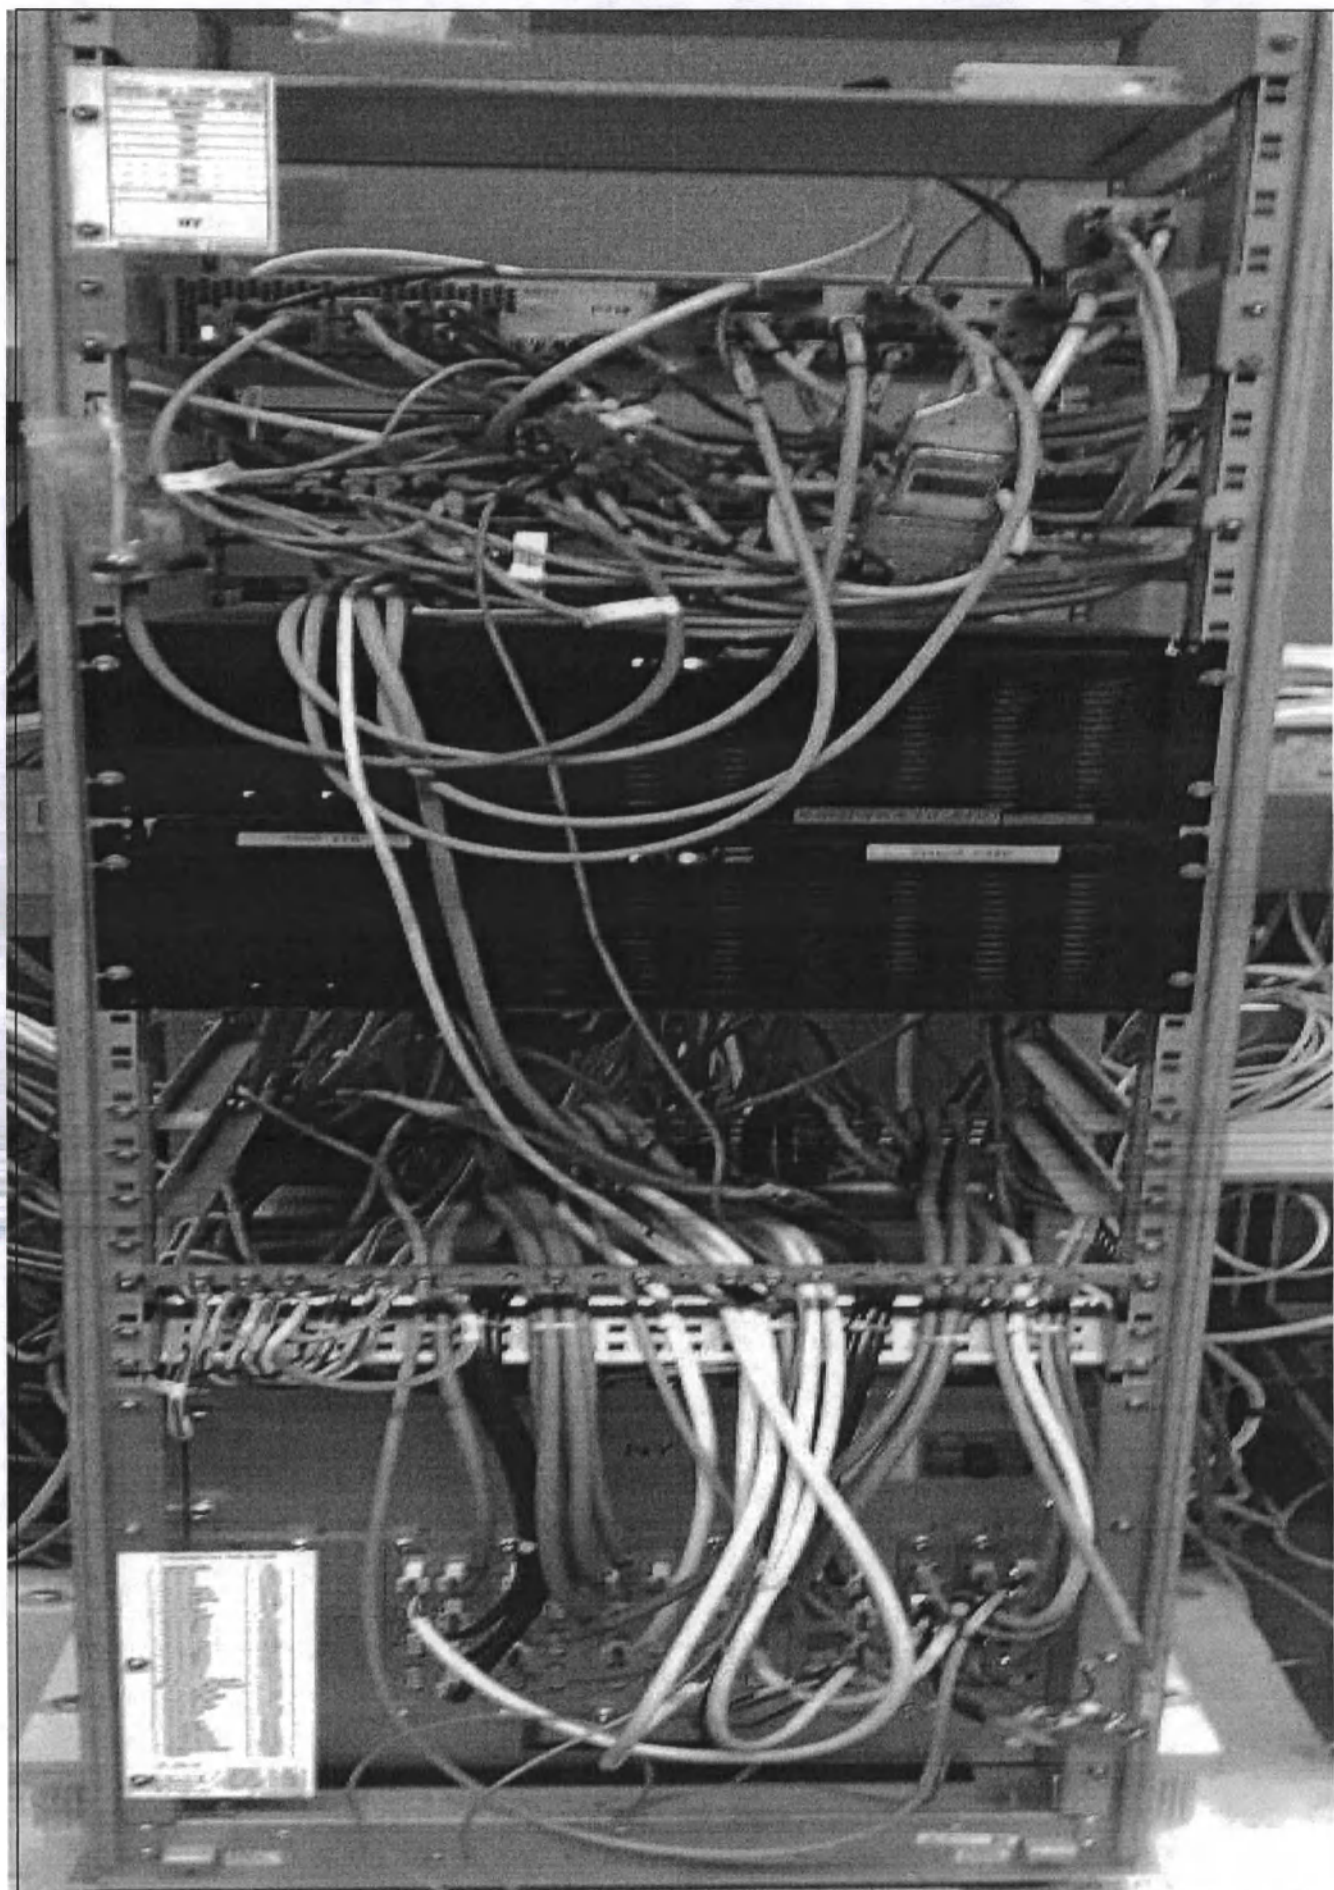


7.а. Распределительный щит.

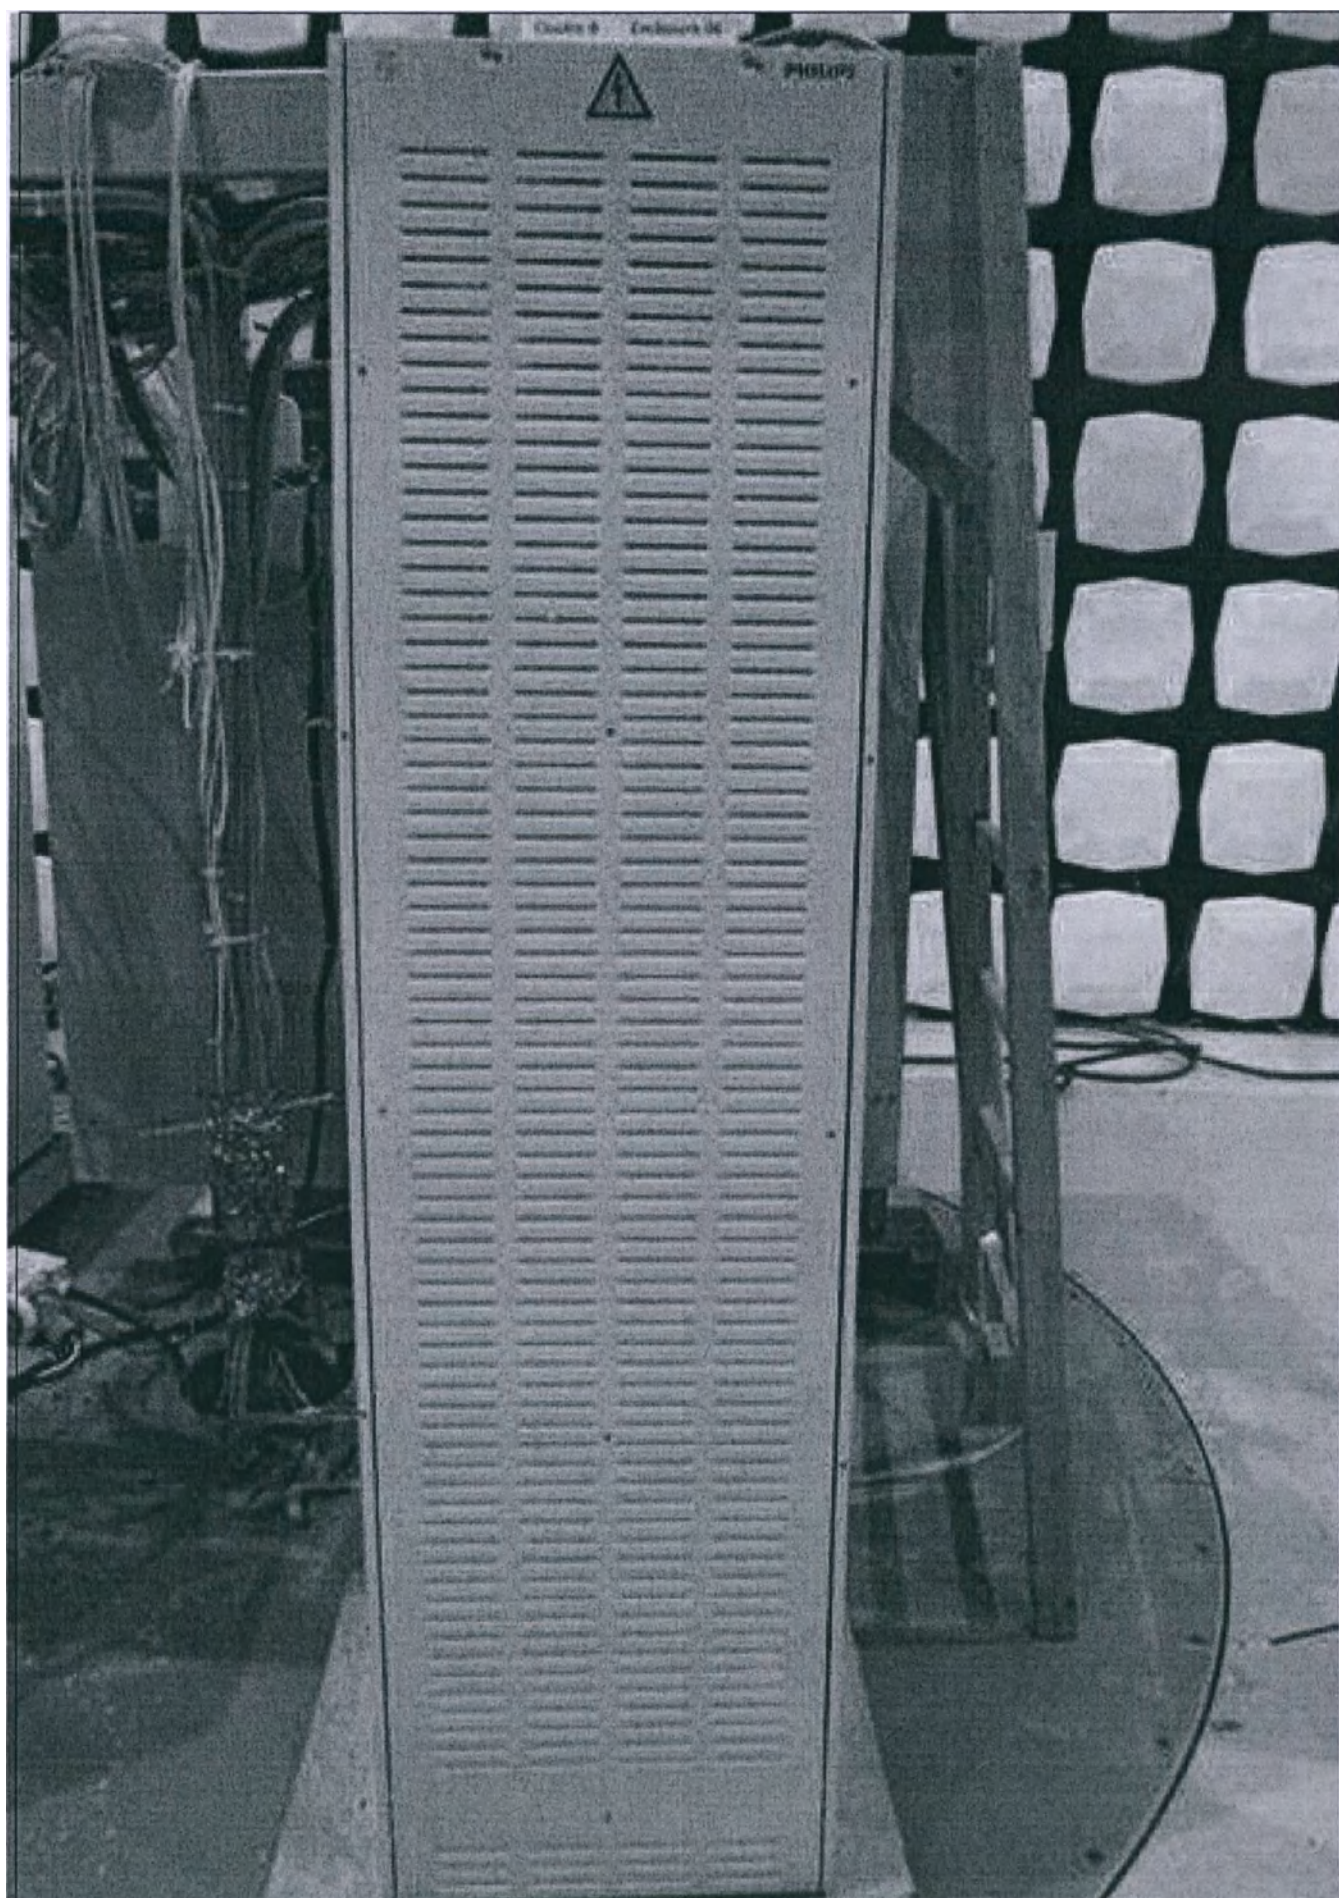


7.6. Распределительный щит.




8. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

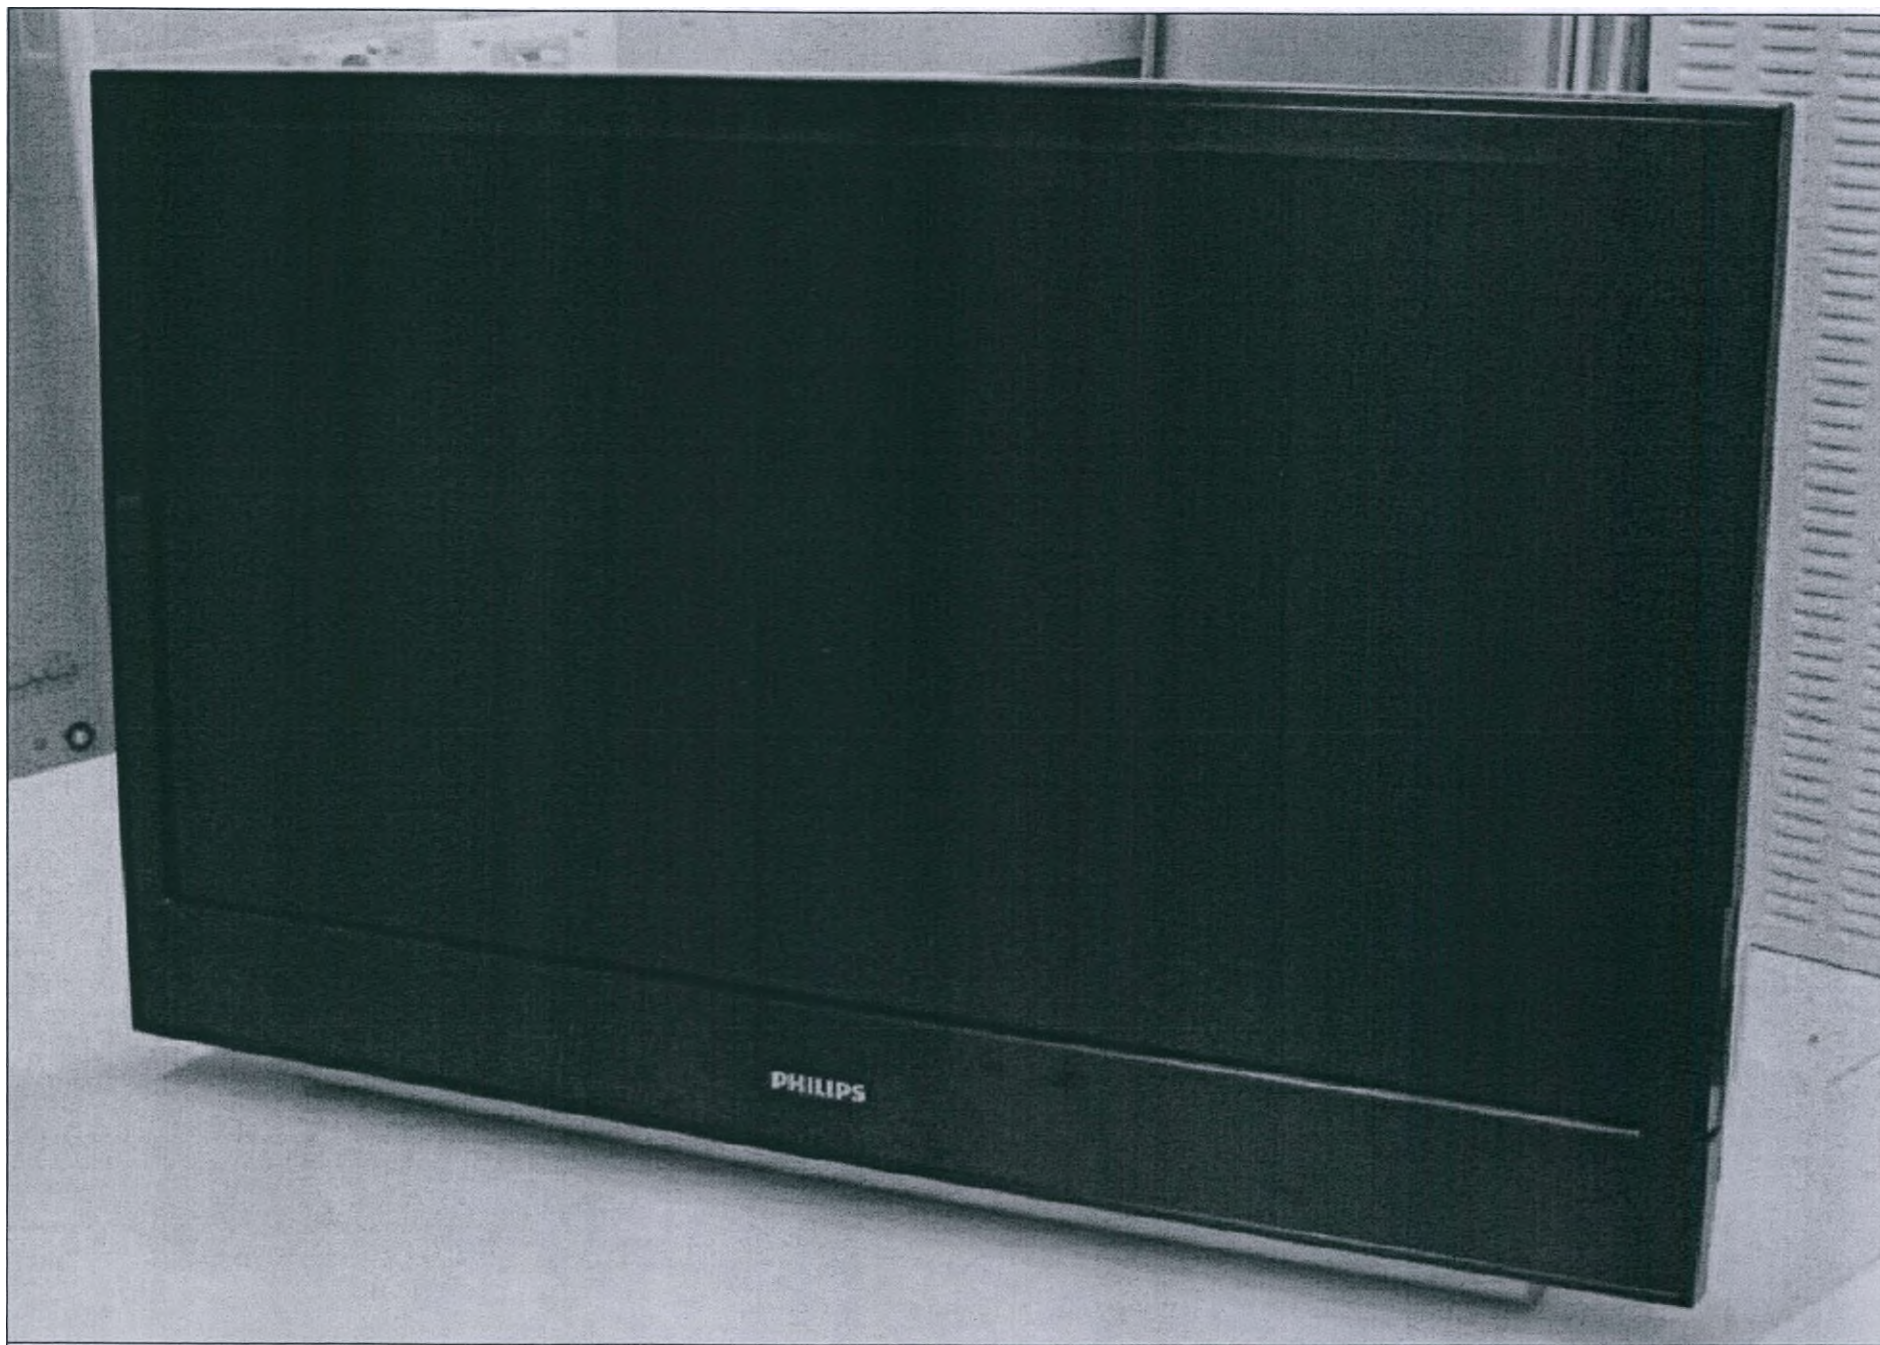

9. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

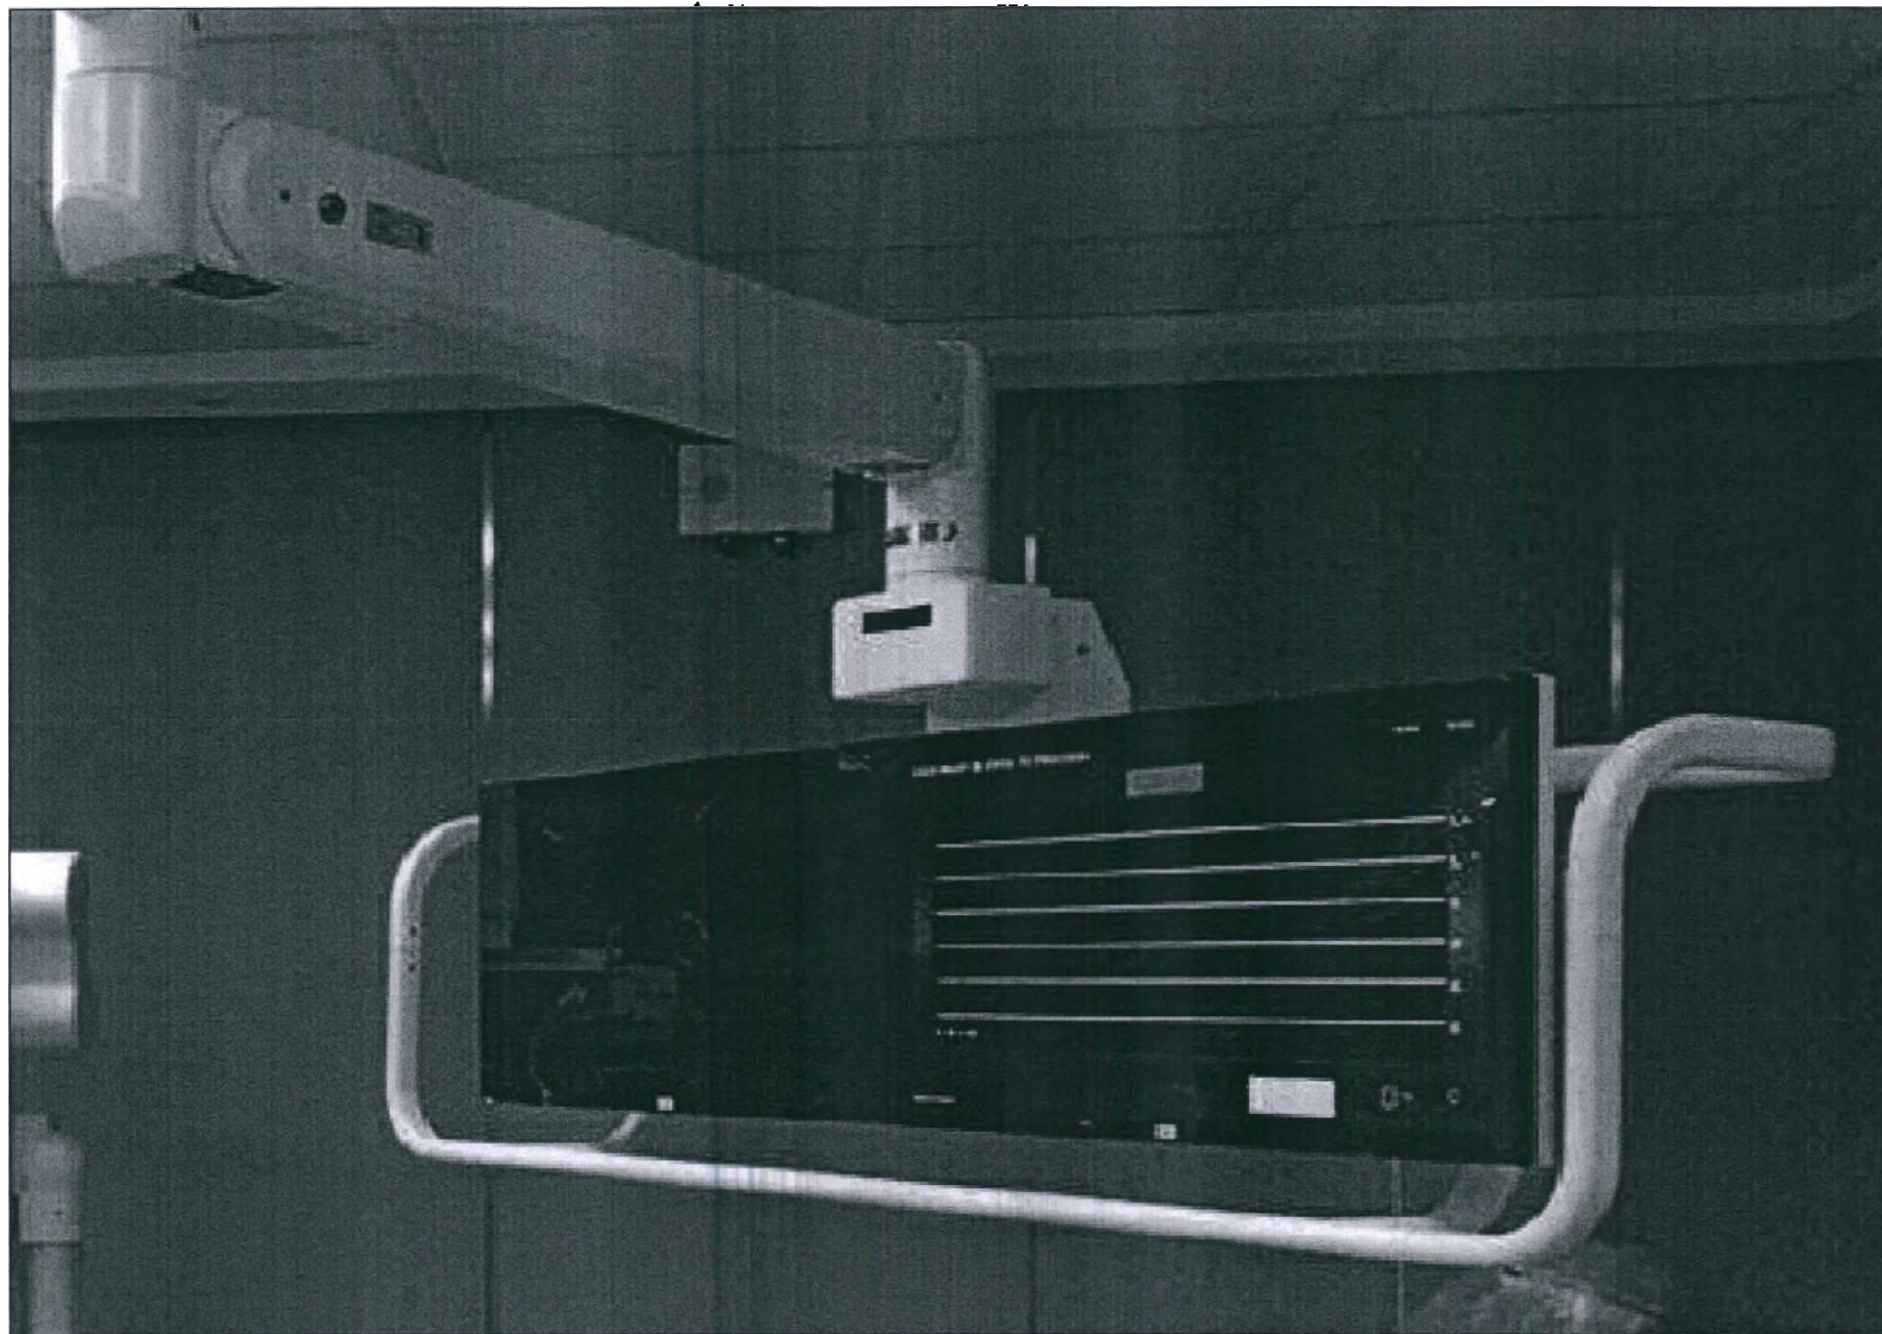


10. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

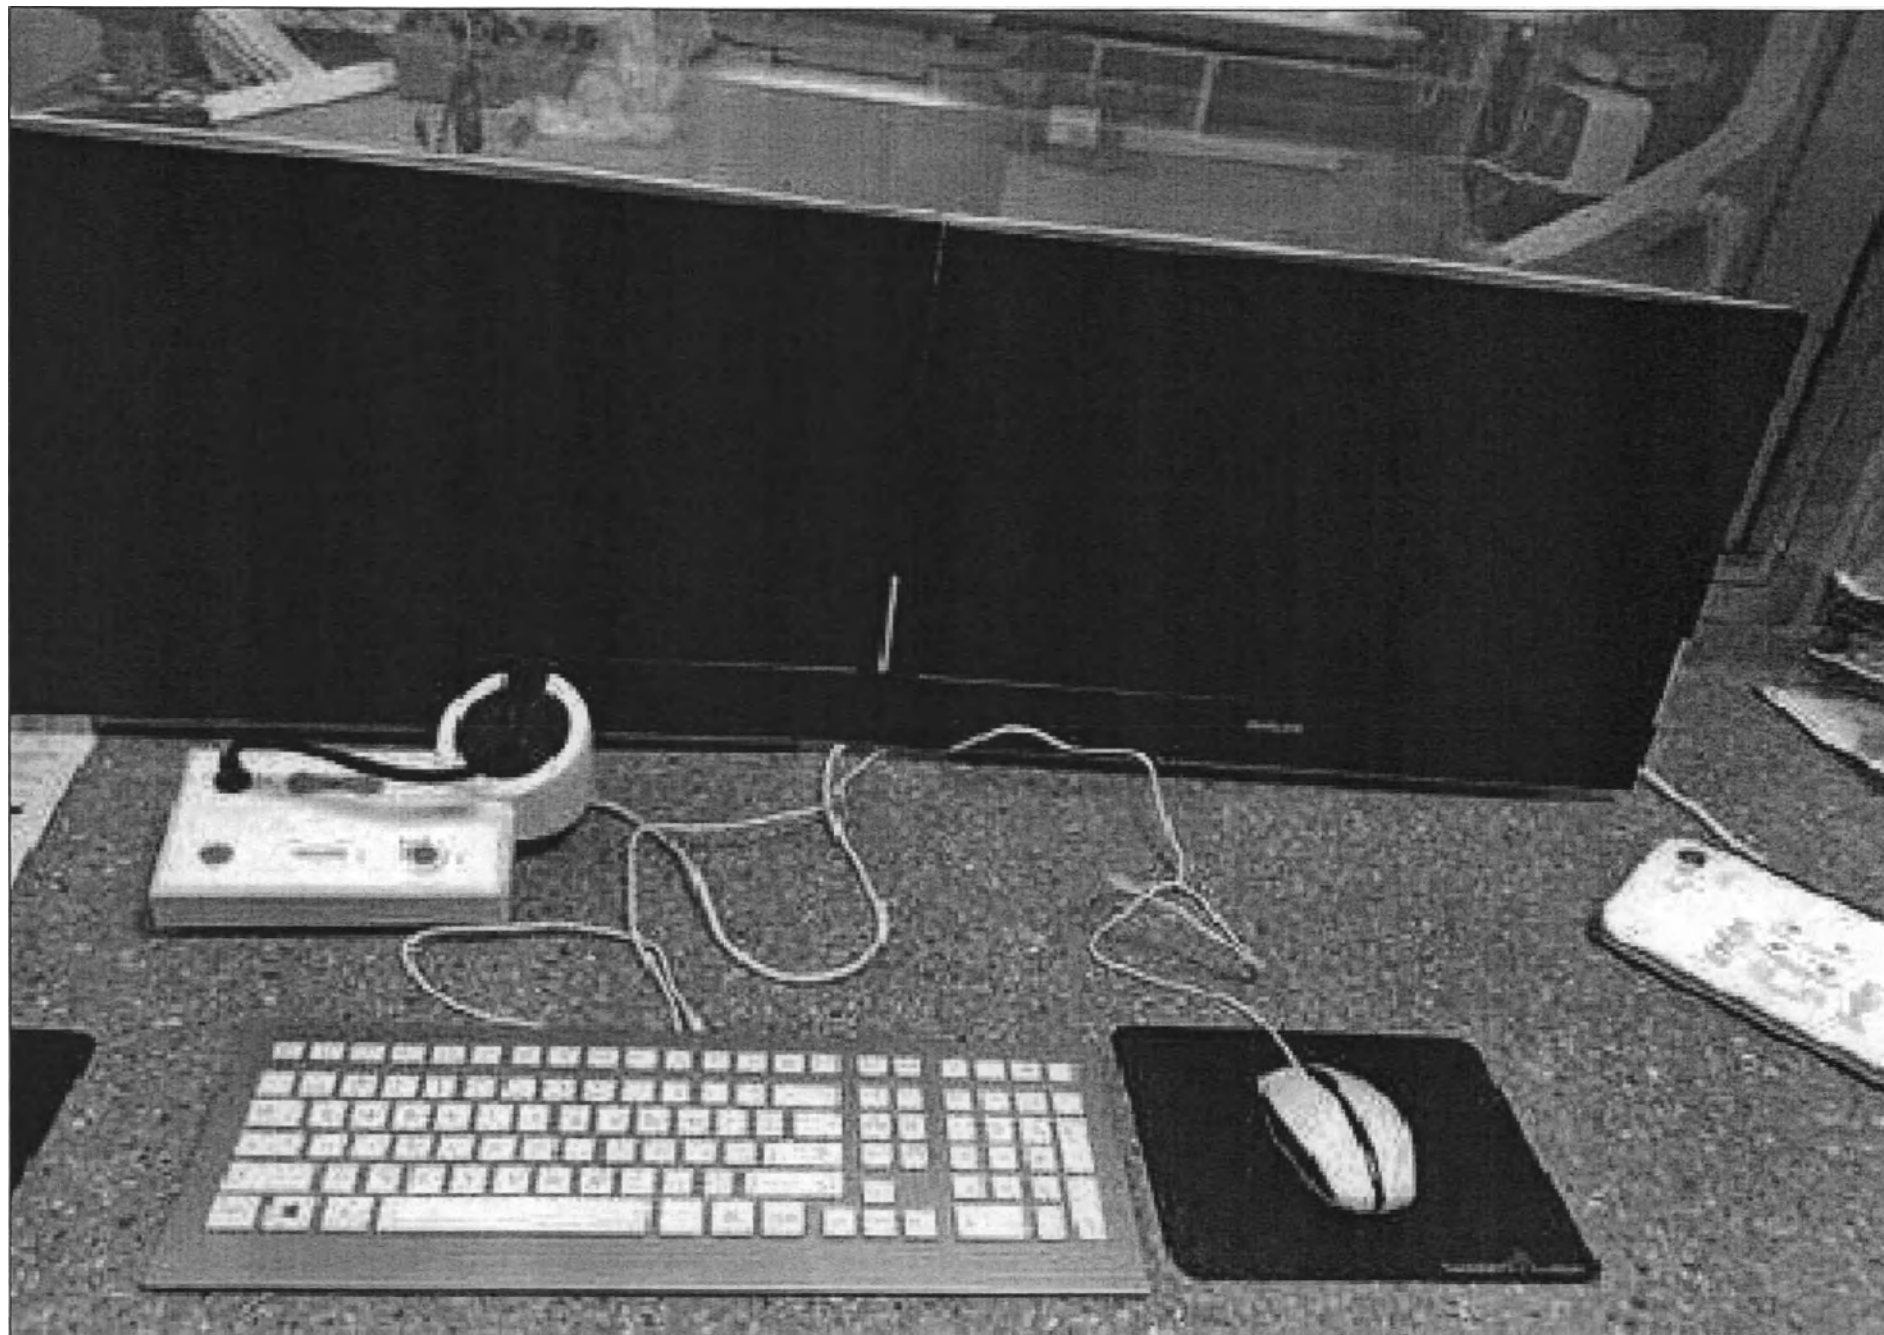


11.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.




11.6. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

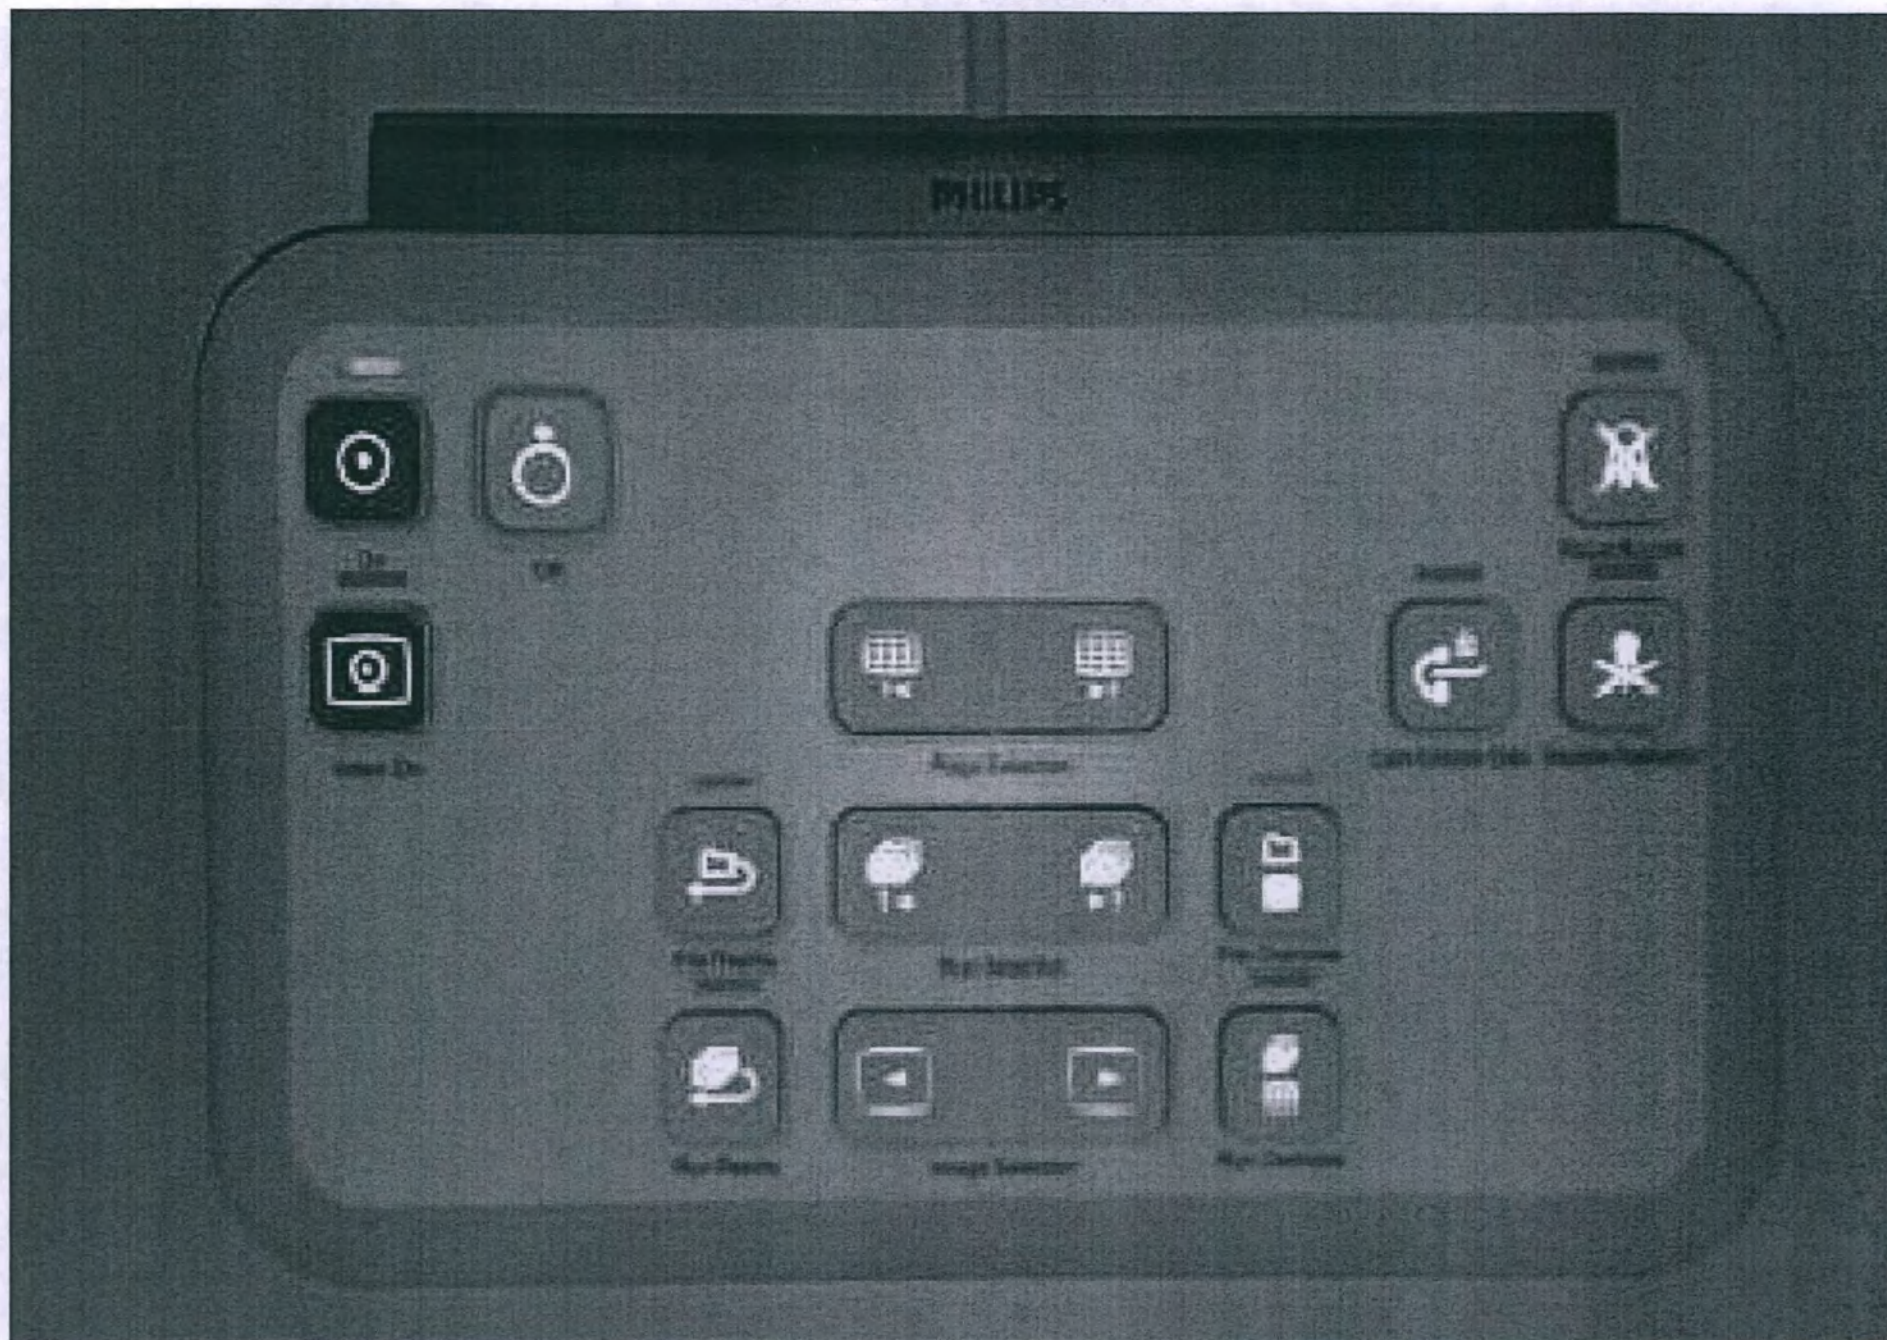


11.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

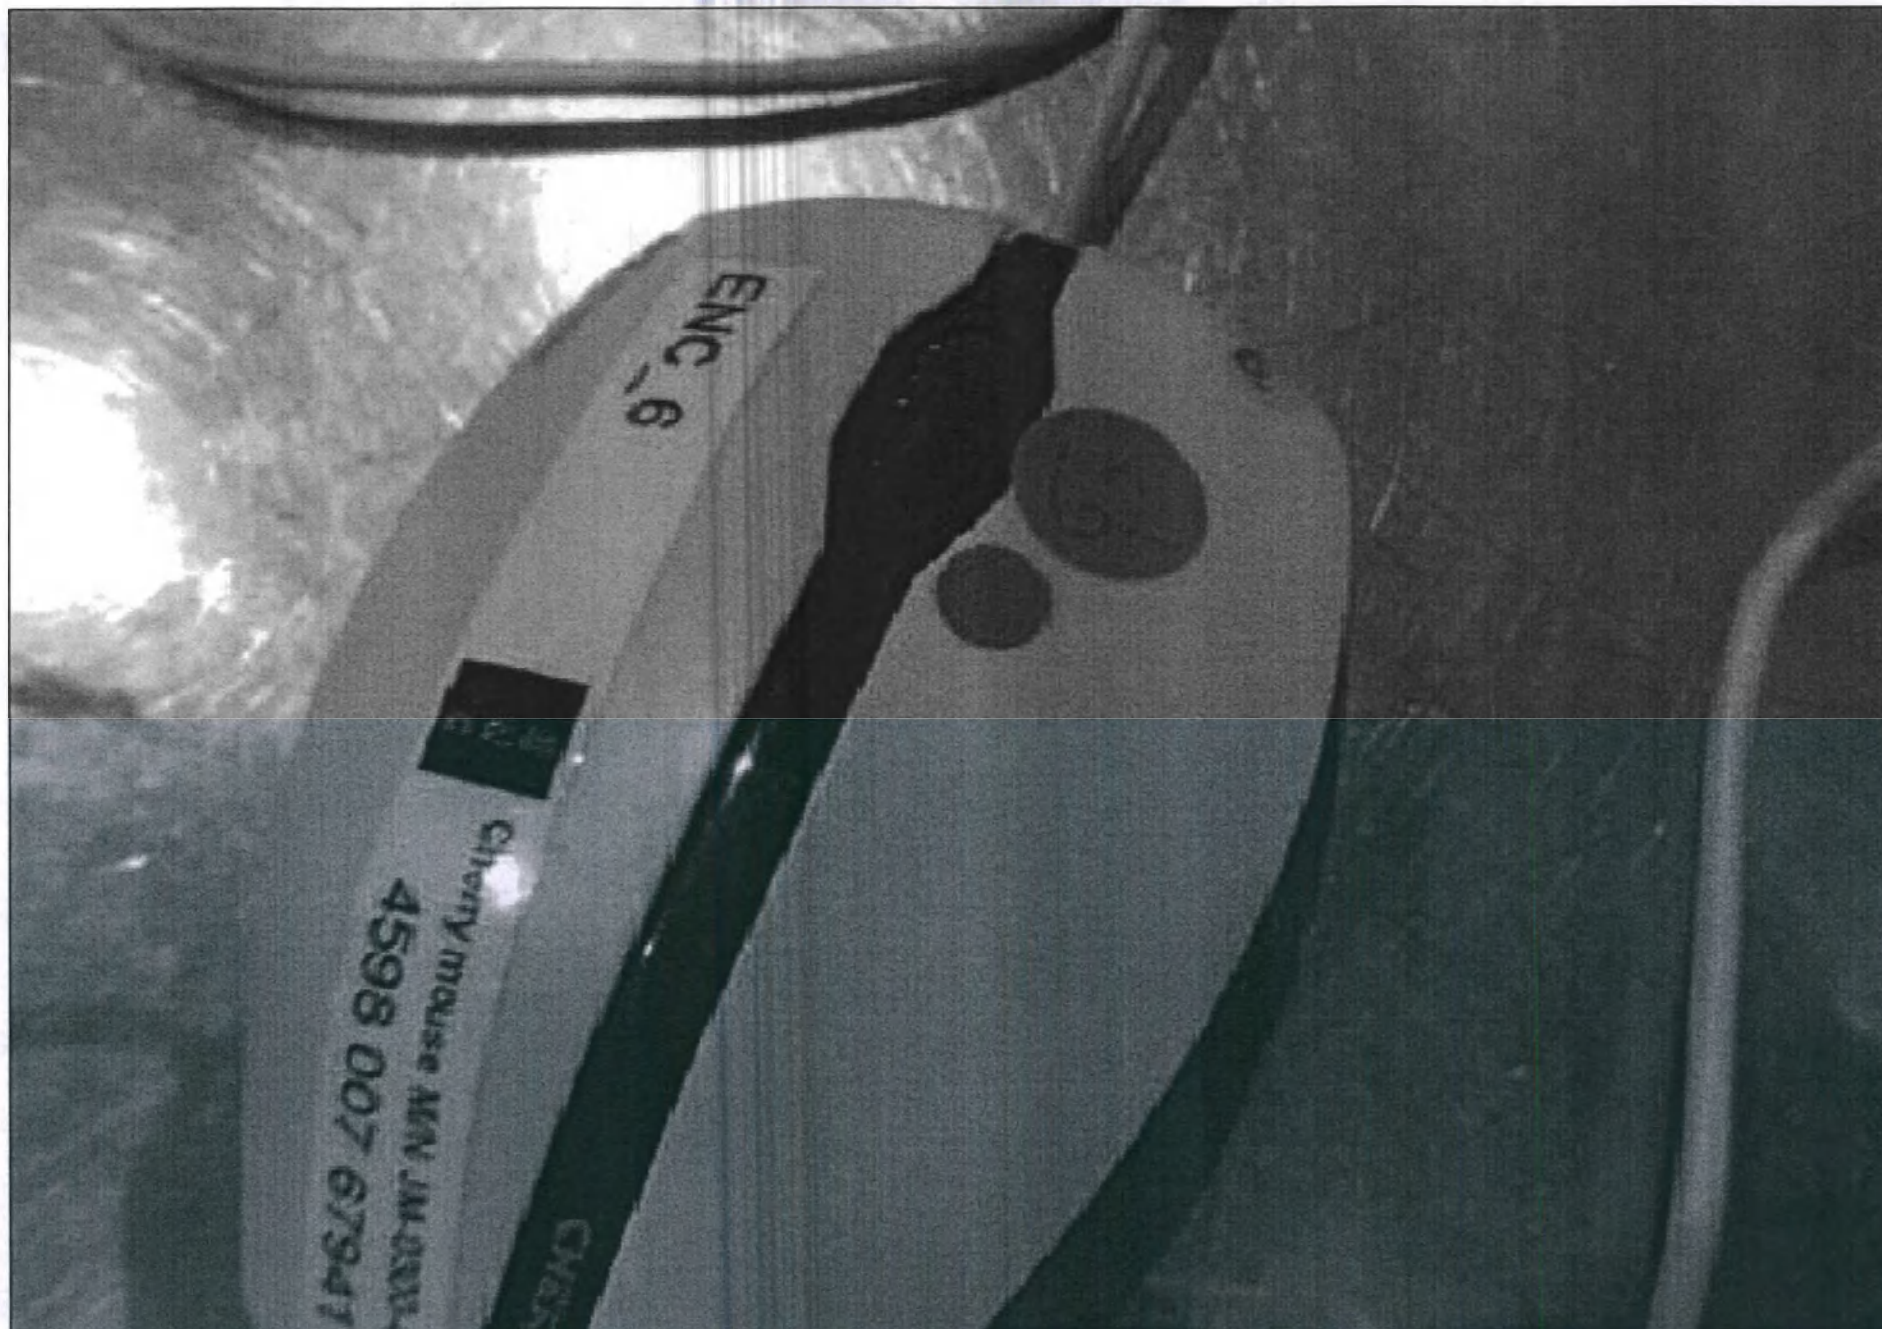


11.2. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; **Мышь**; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

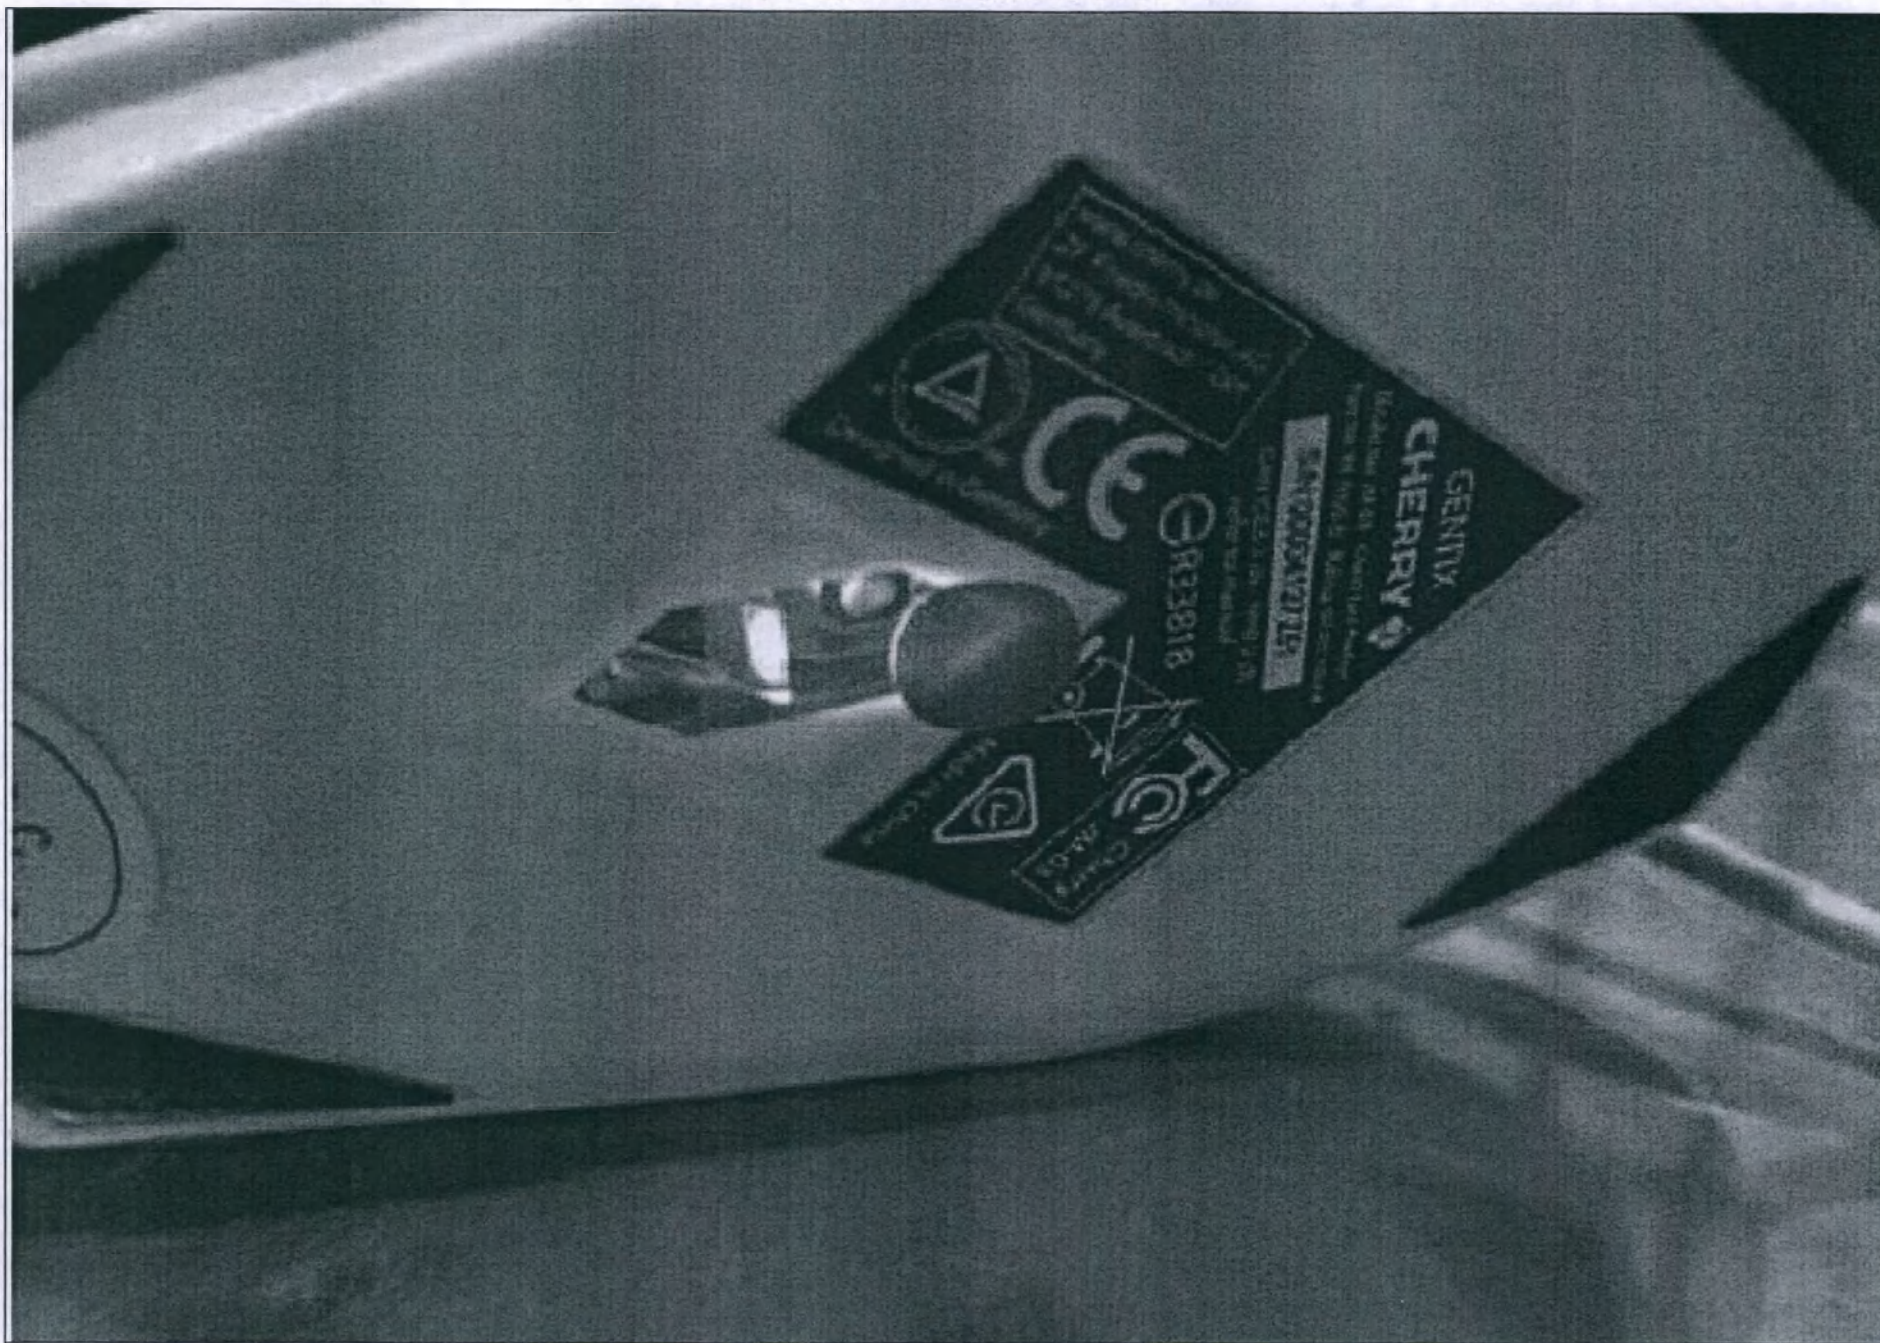


11.д. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; **Мышь**; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

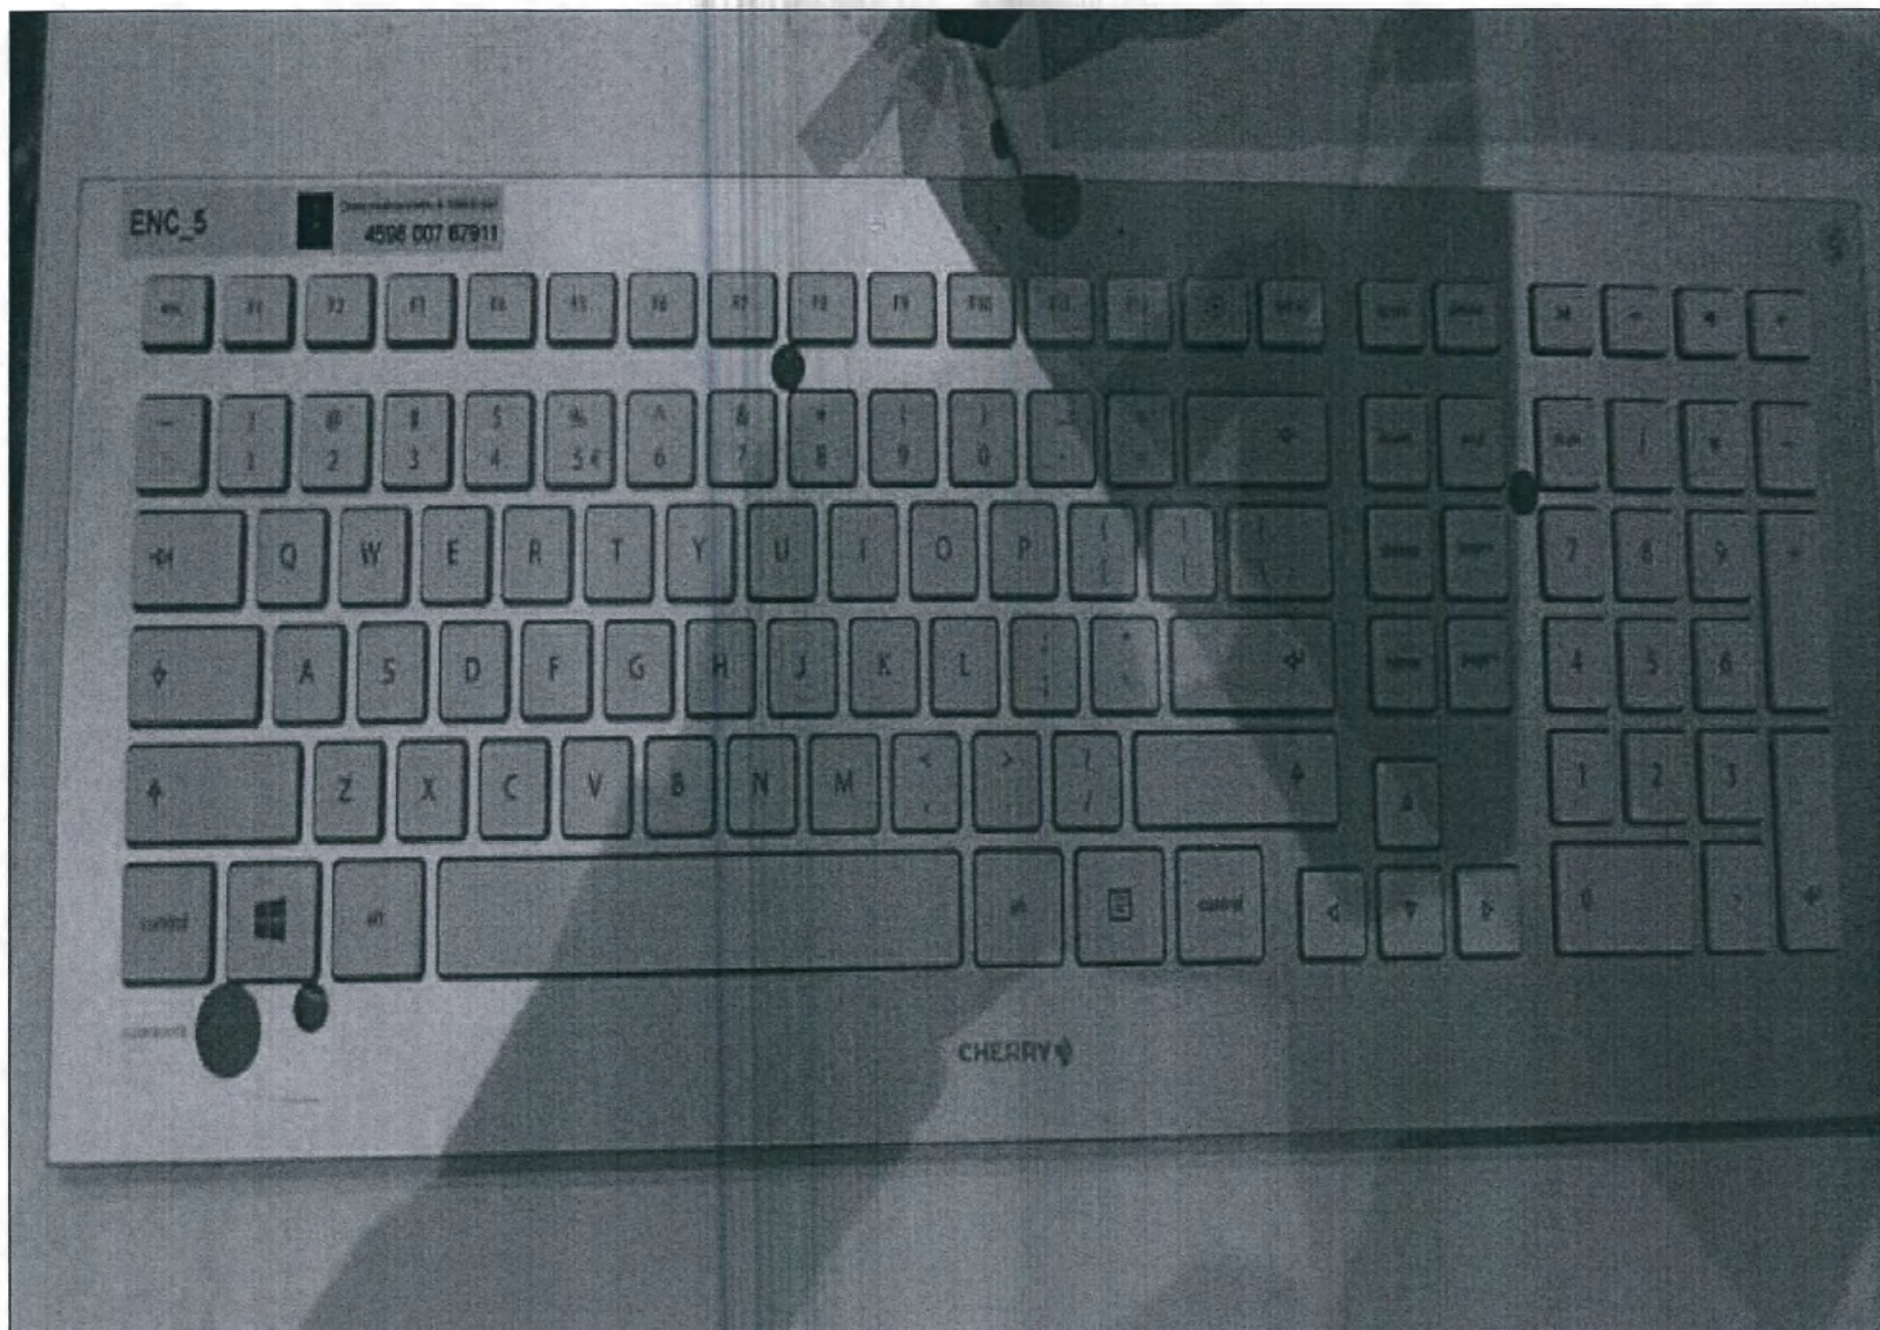


Ил.е. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

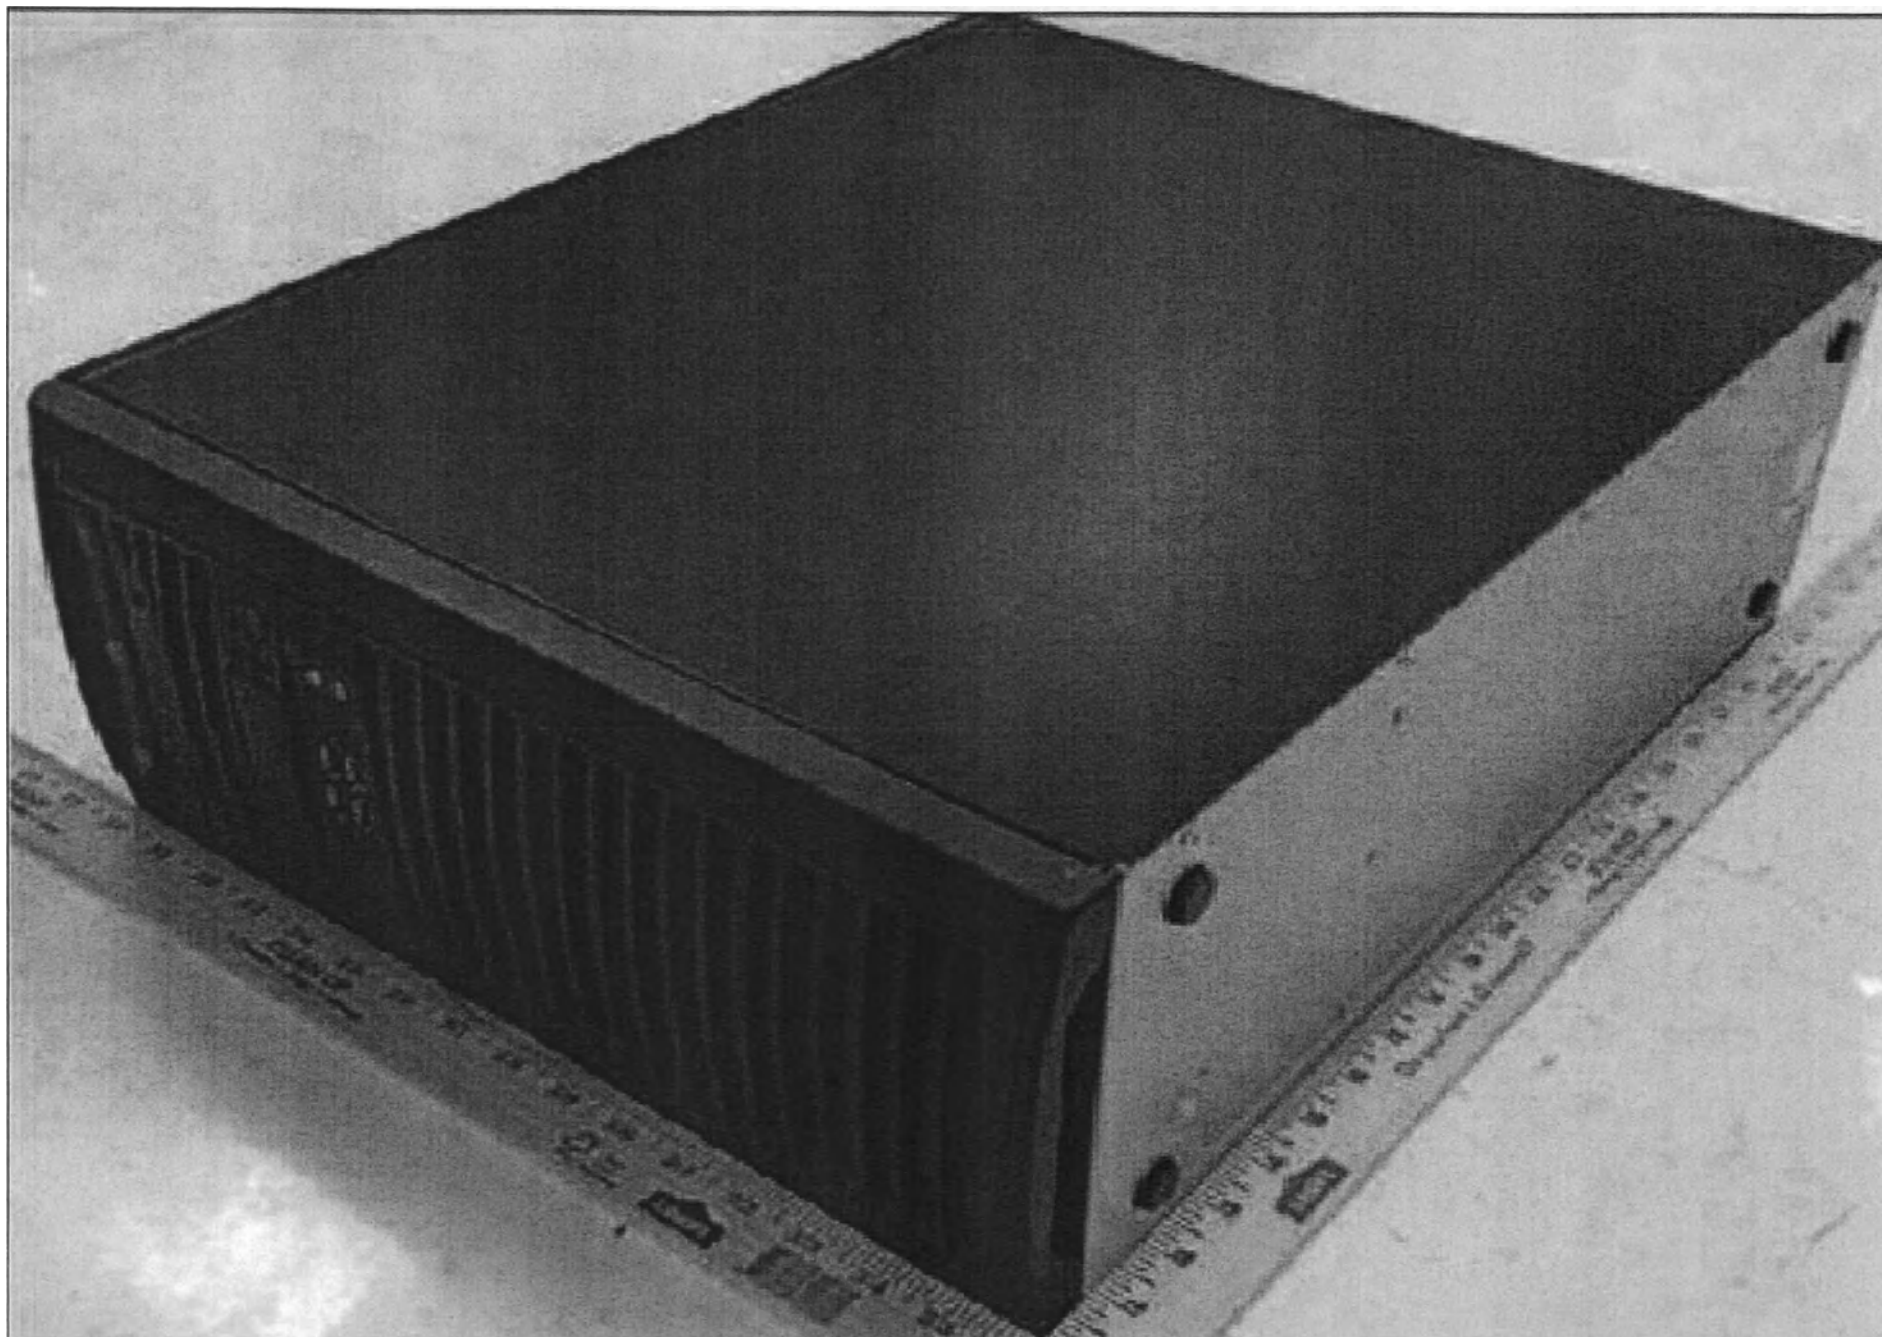


11.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Азигіон версия 1.2 и выше.

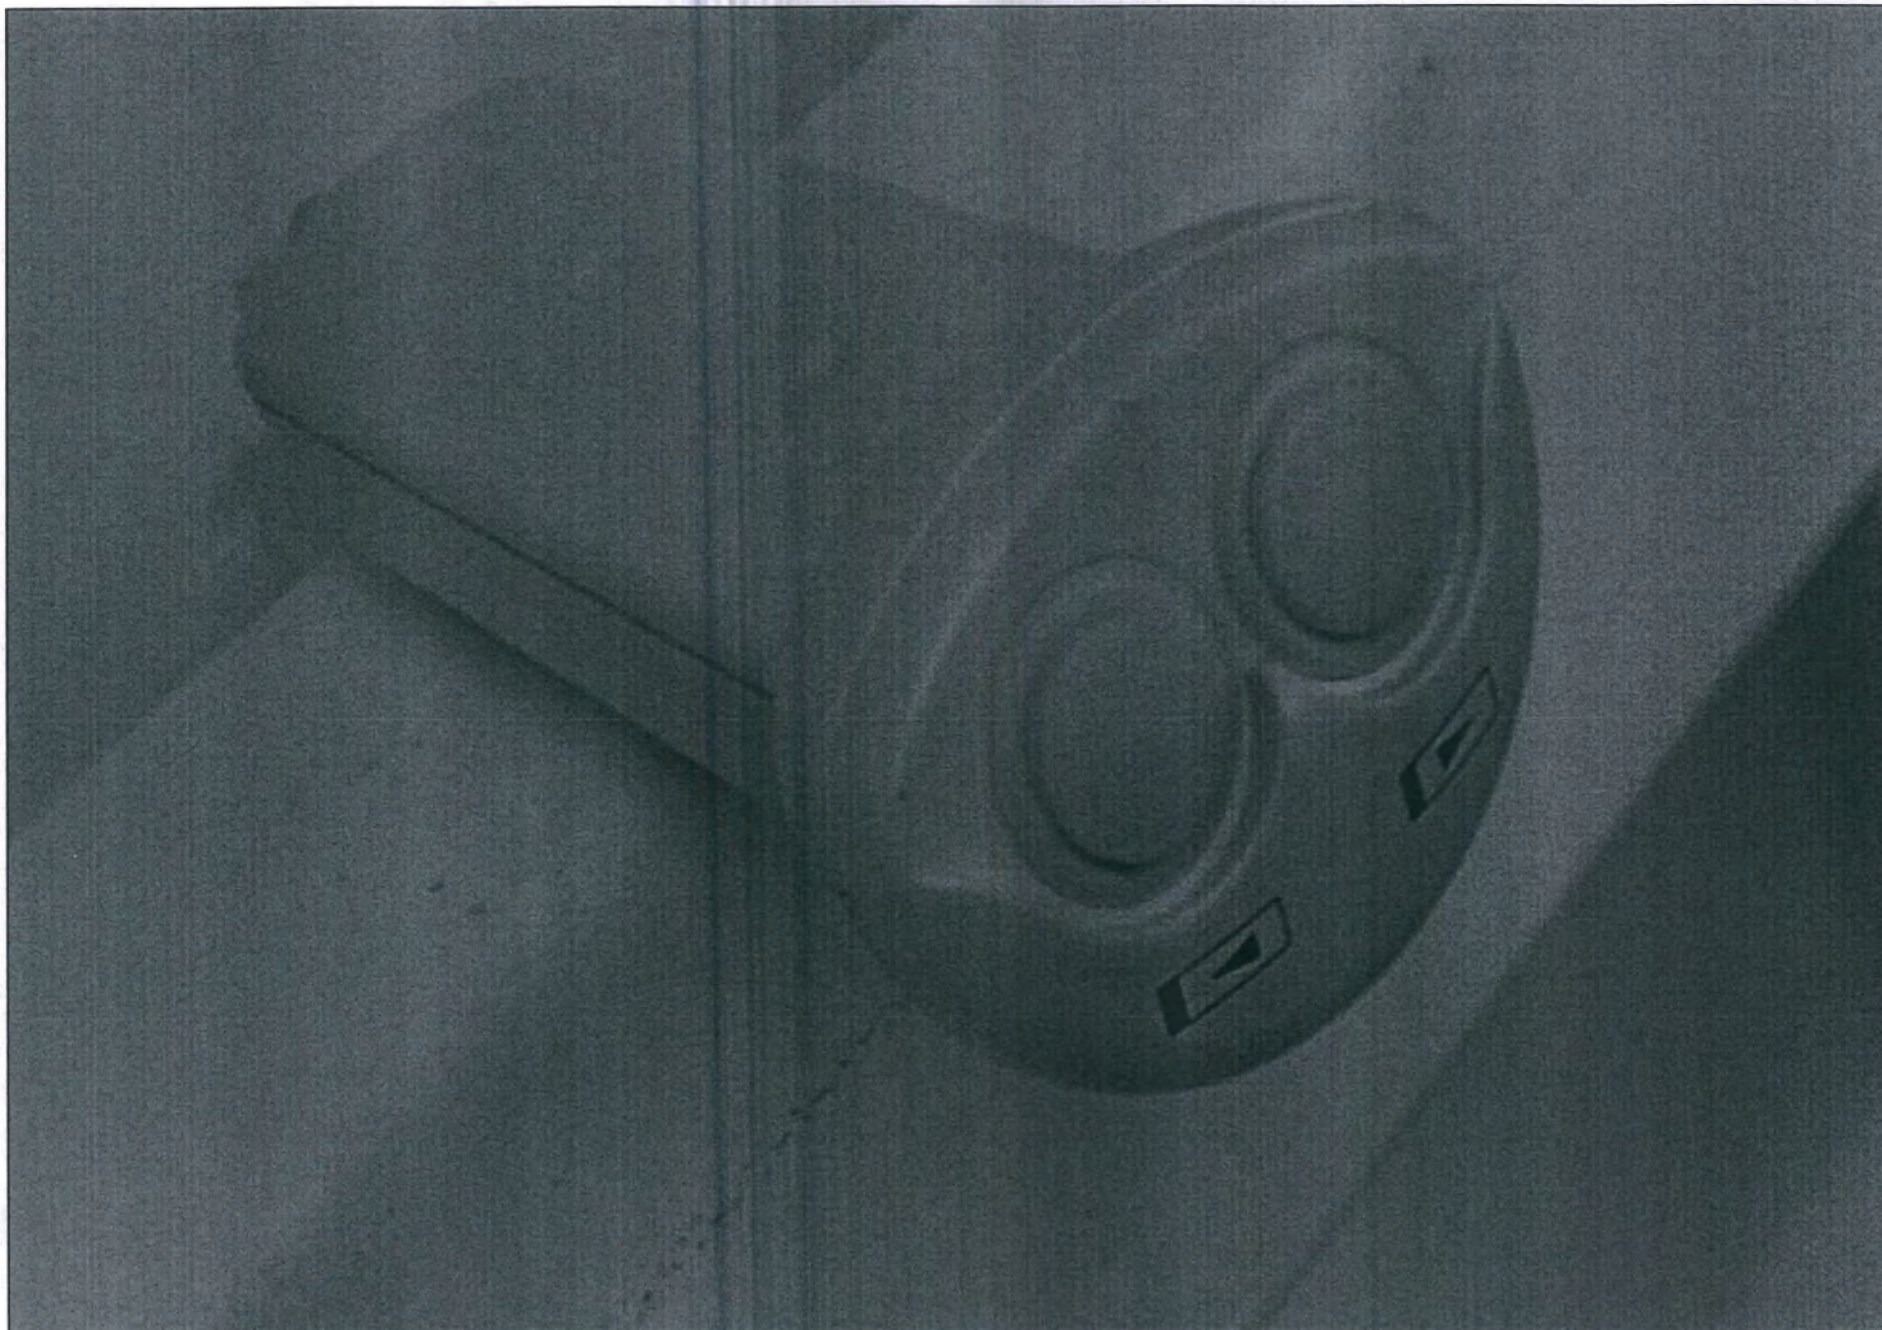


12. Ручной переключатель сдвига.

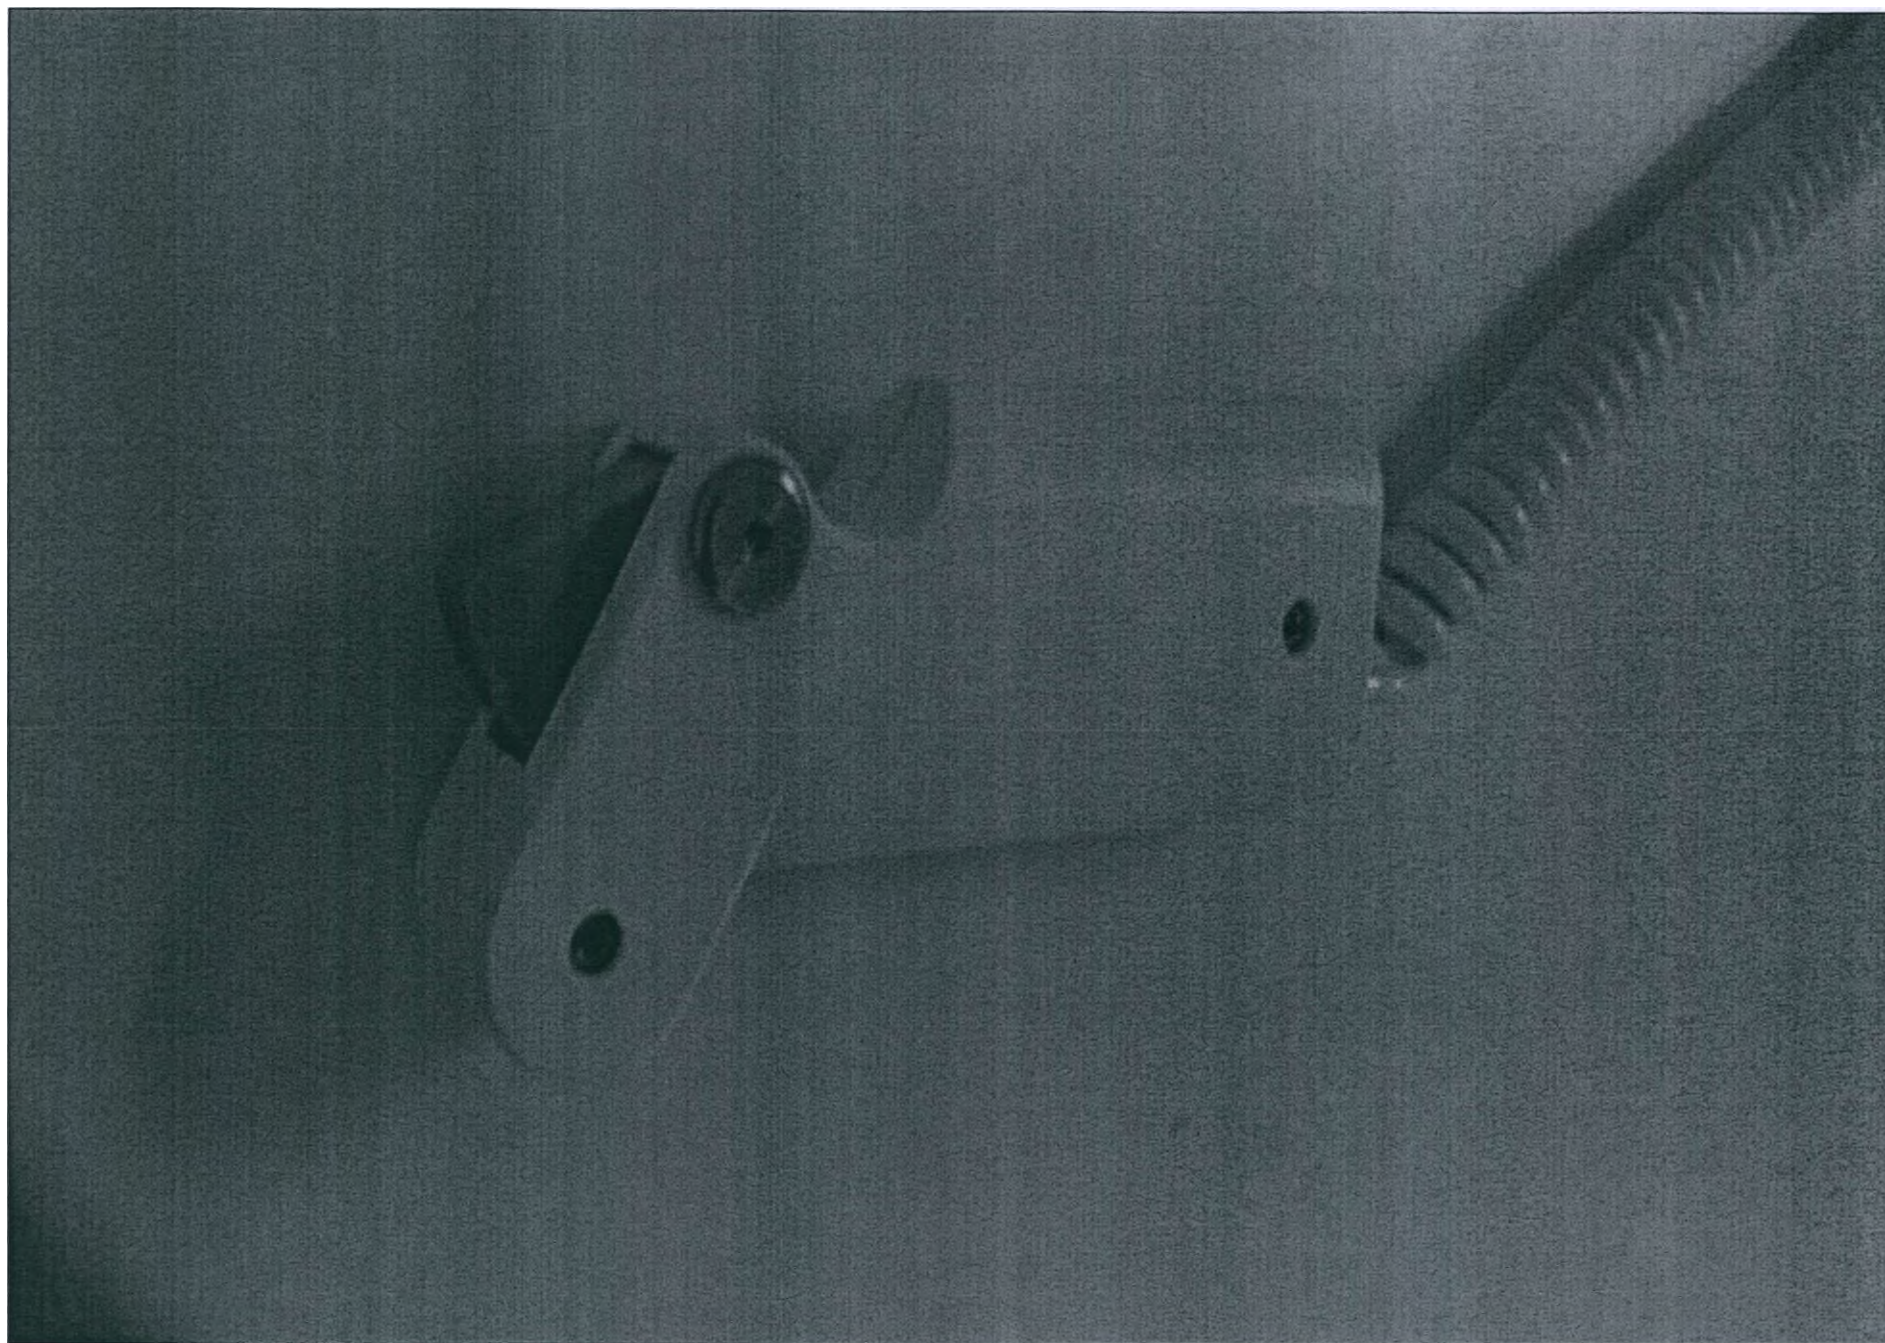


13. Регулятор скорости.

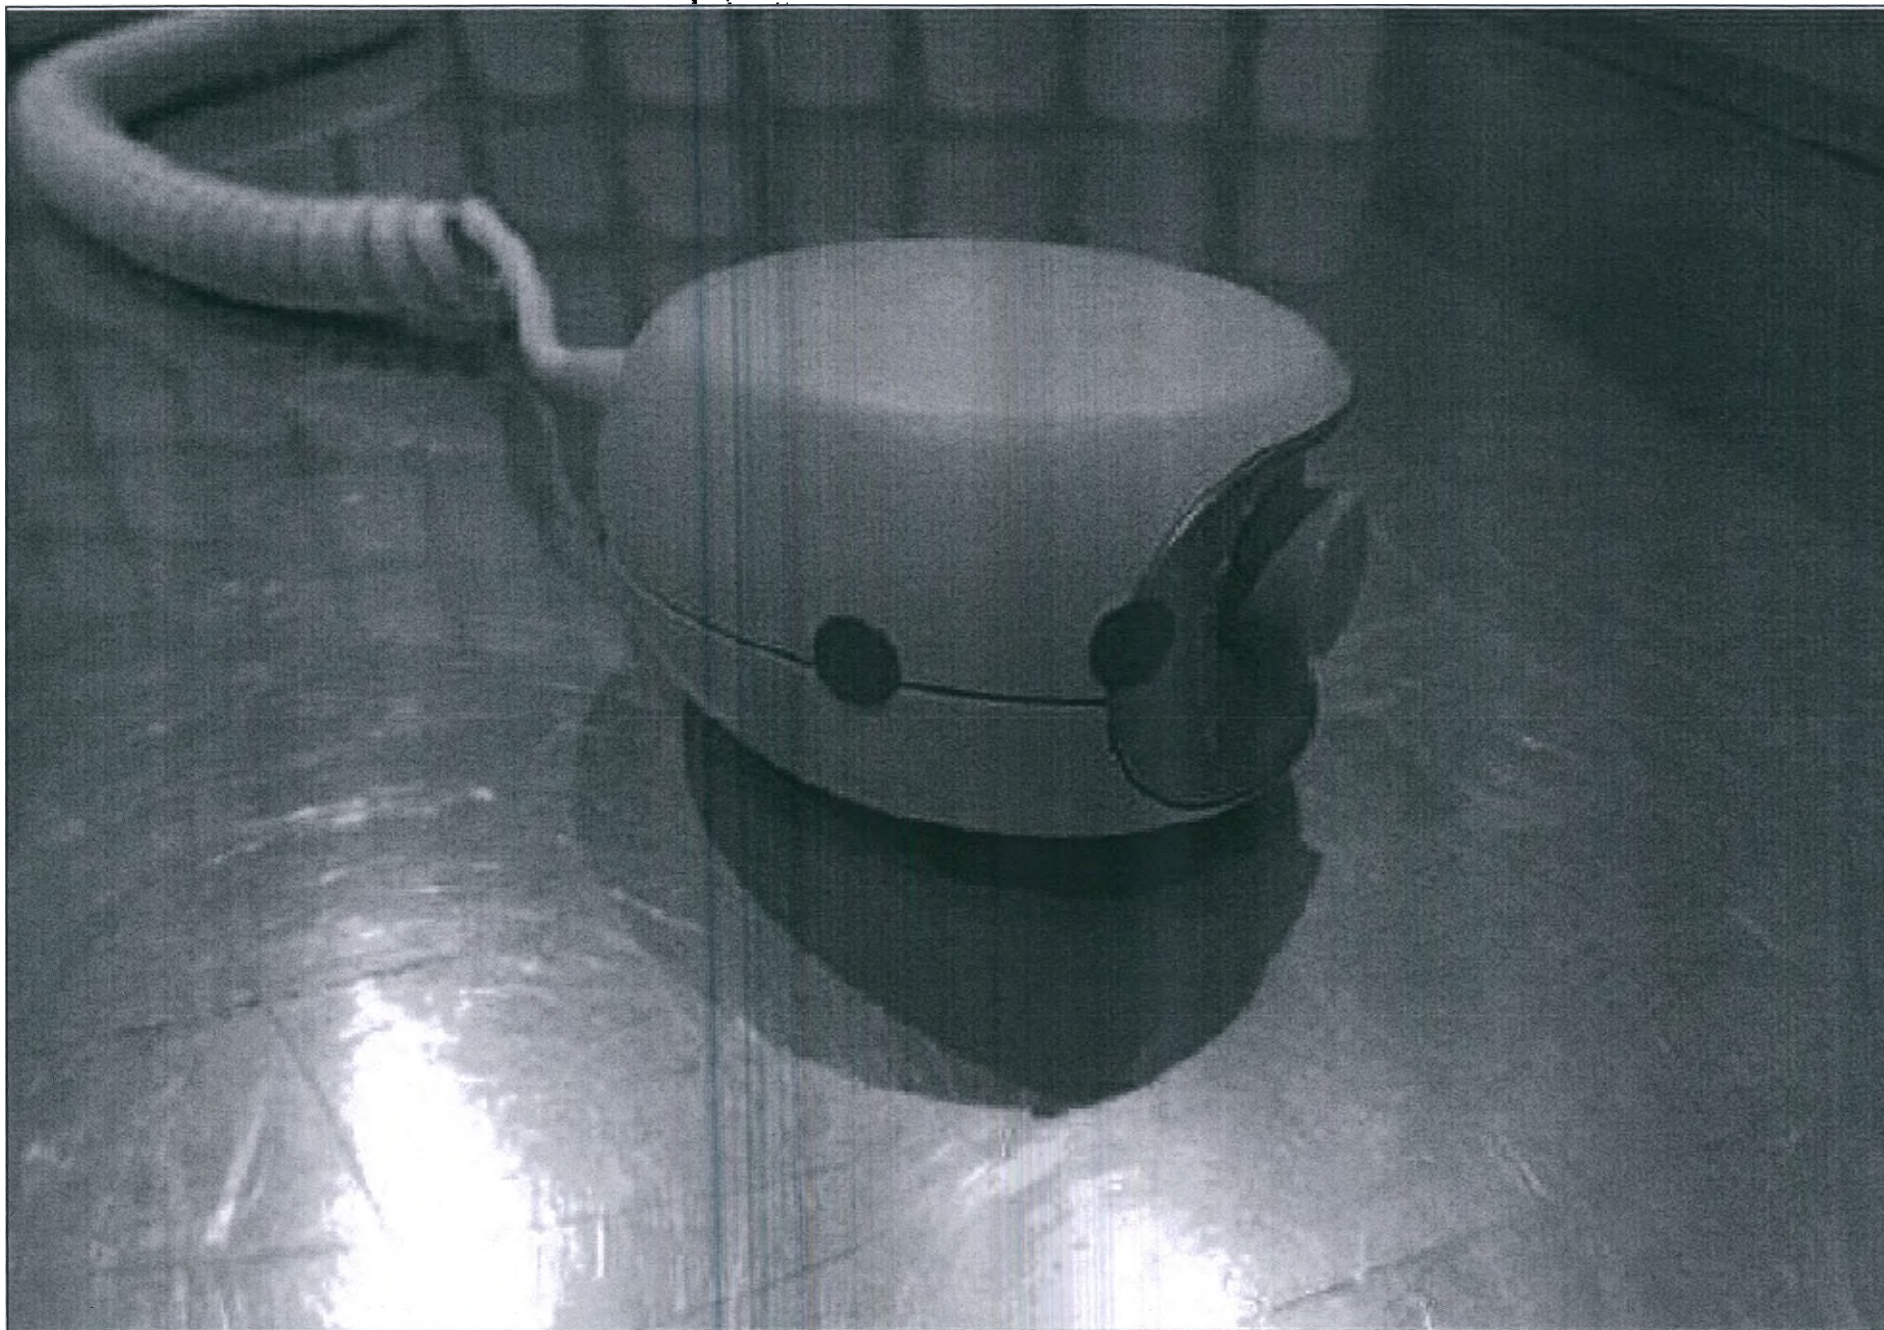


14. Ручной переключатель экспозиции.

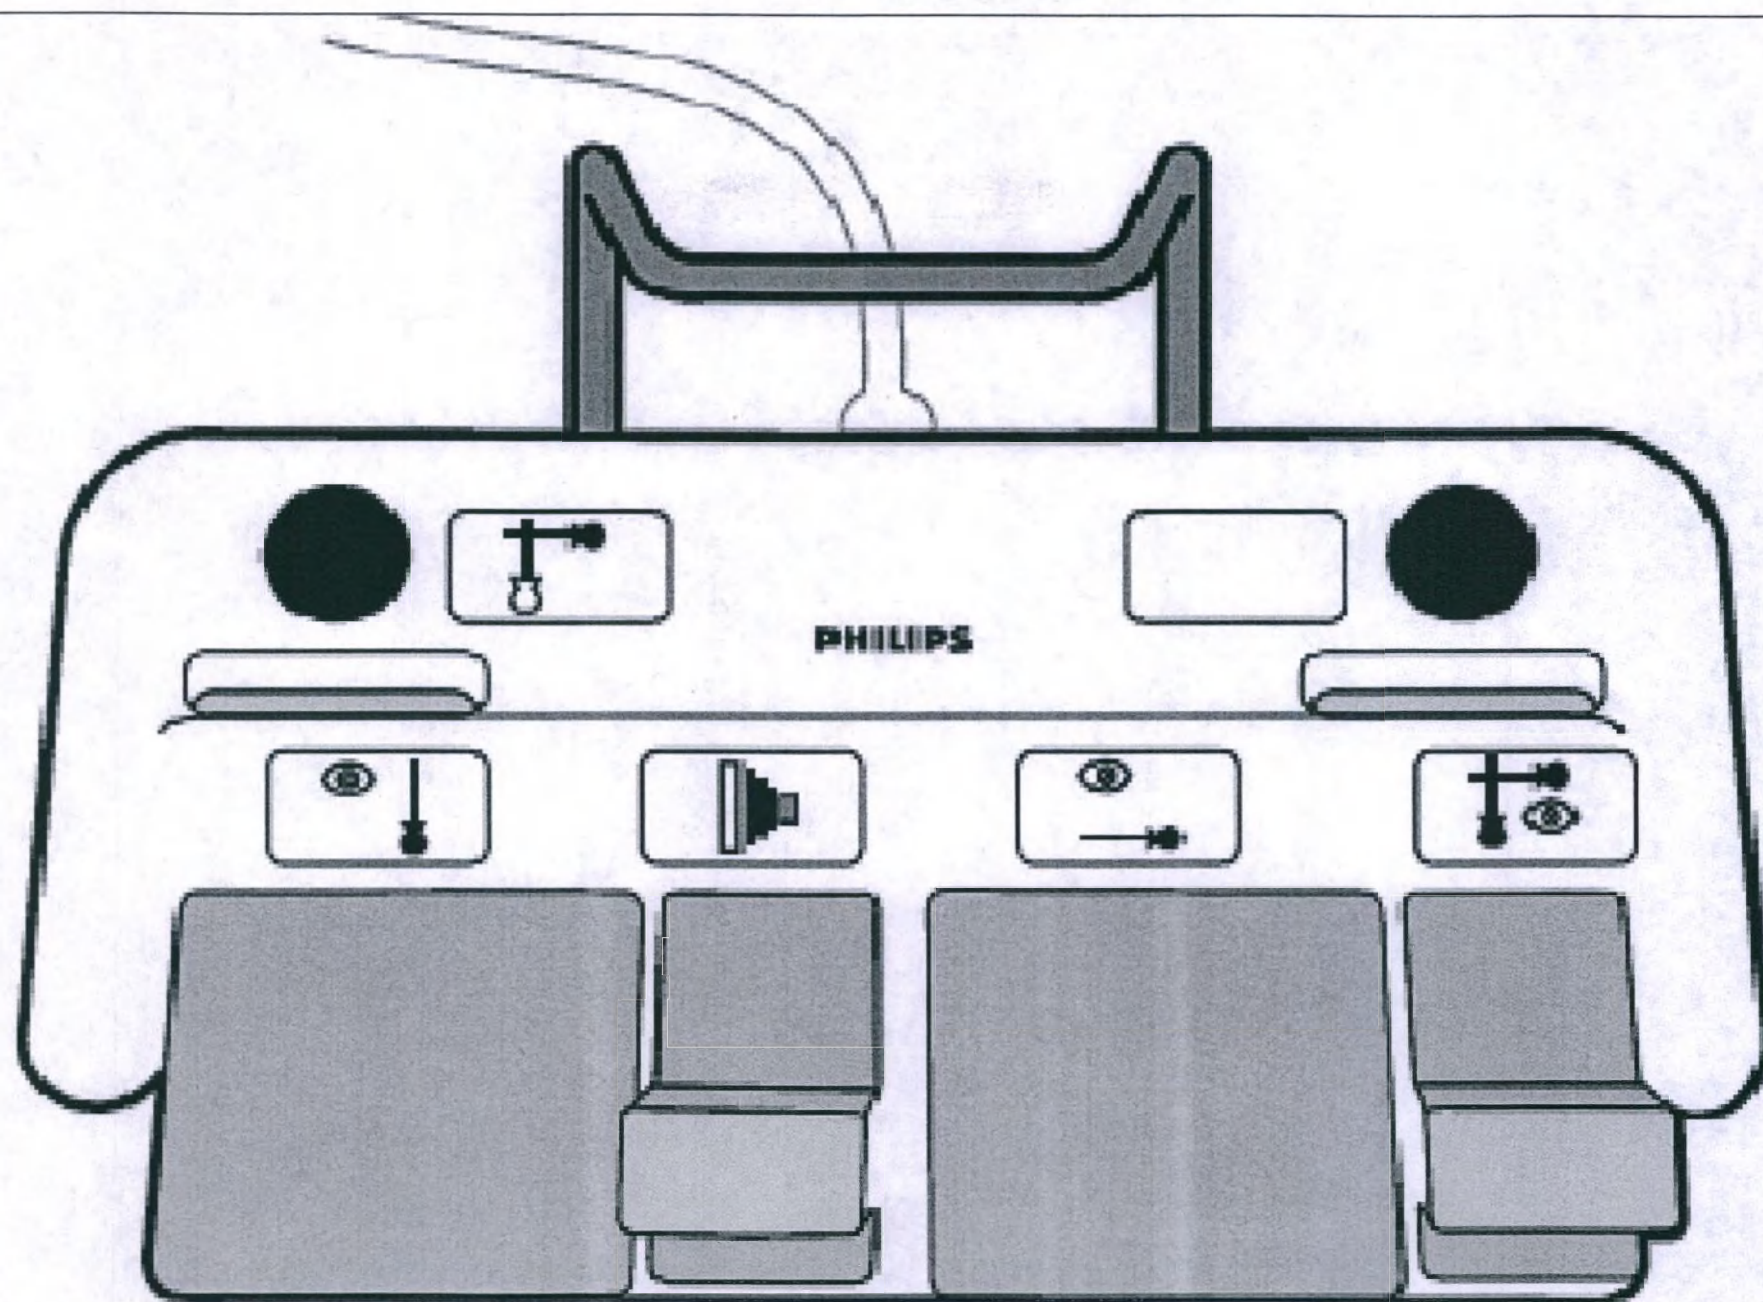


15. Ножной переключатель, не более 2 шт.

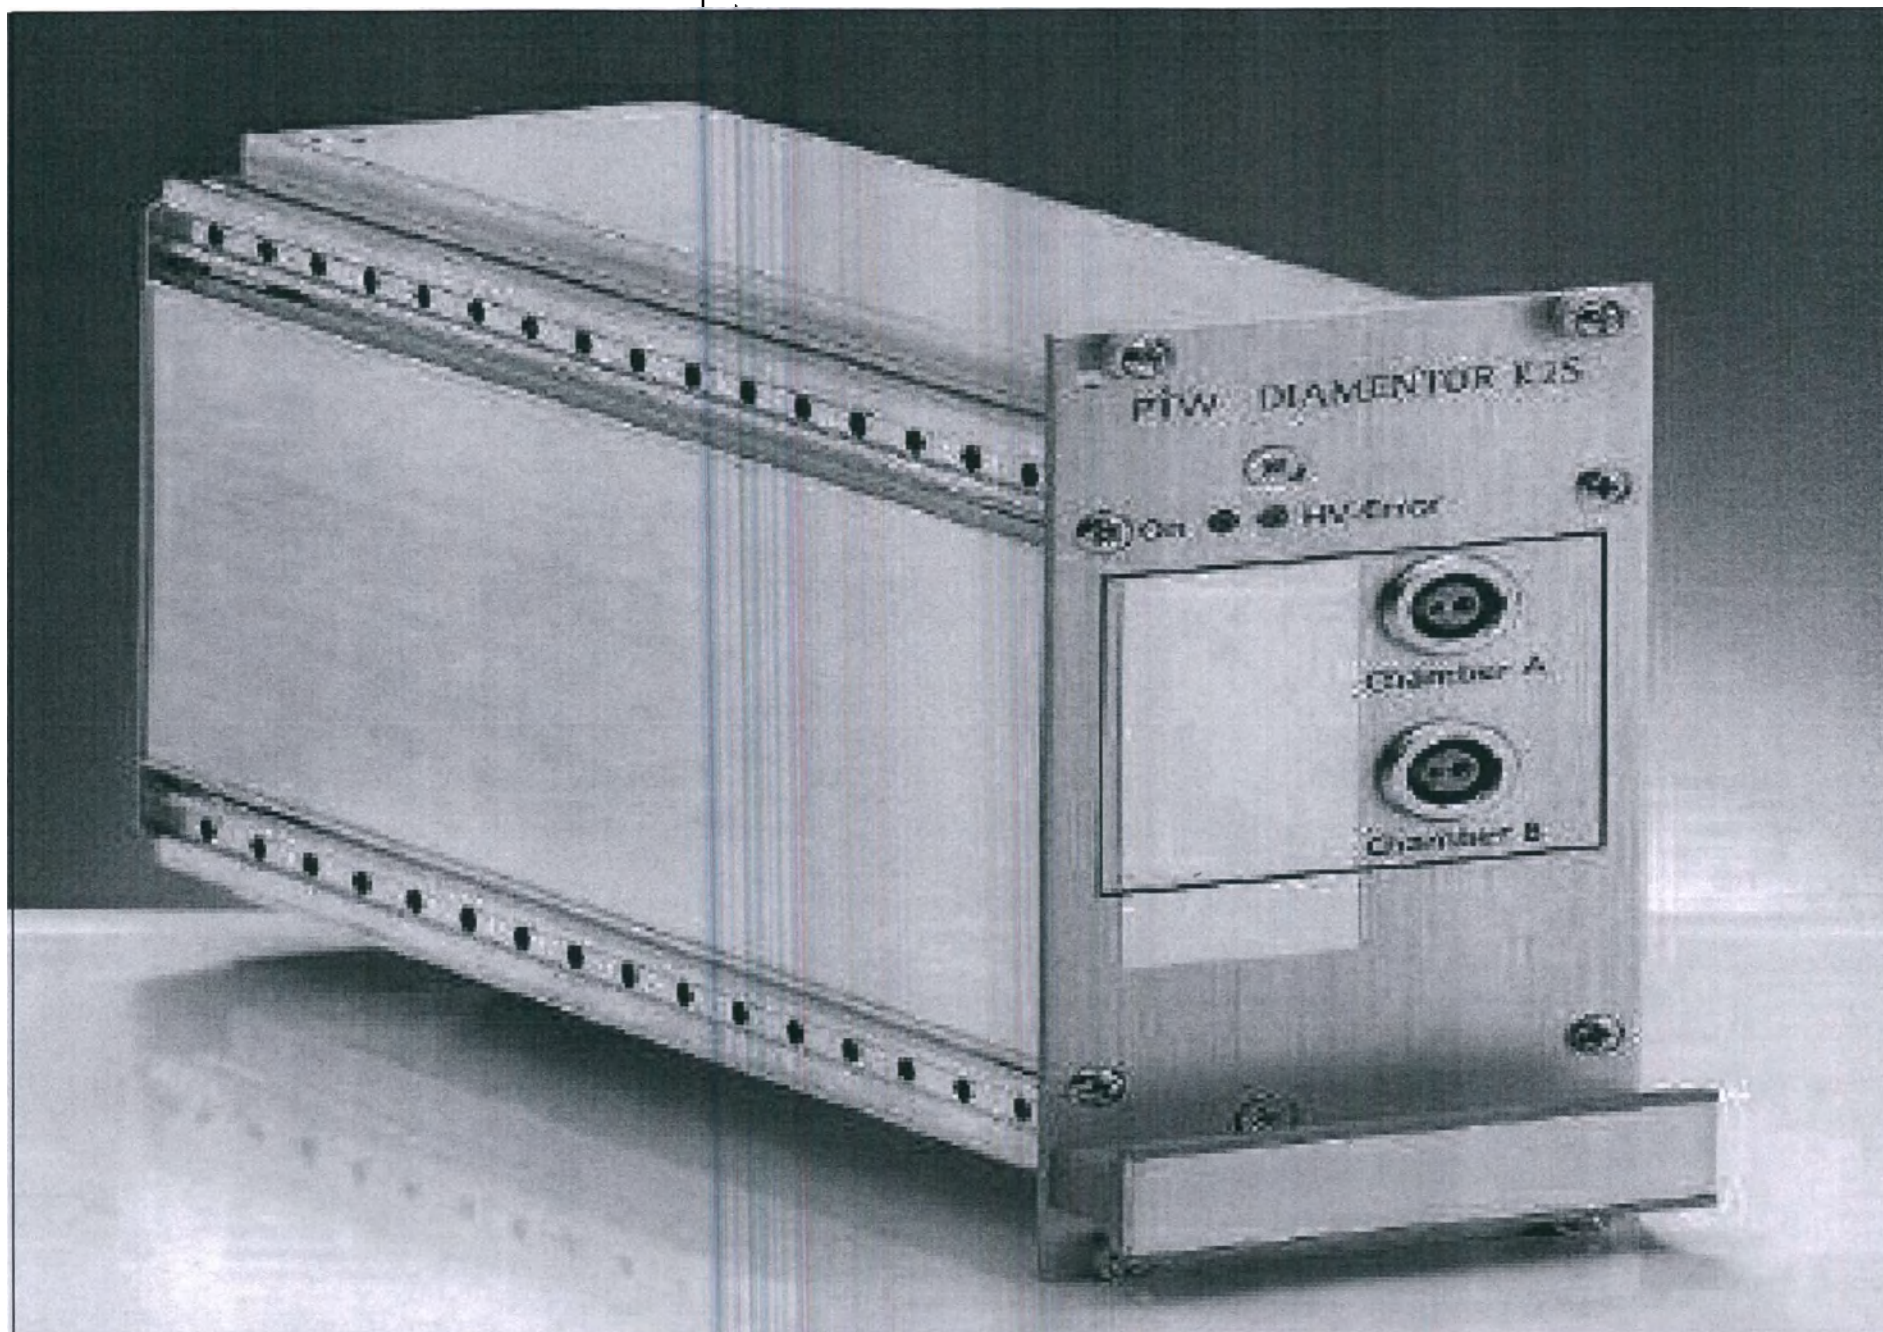


16.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

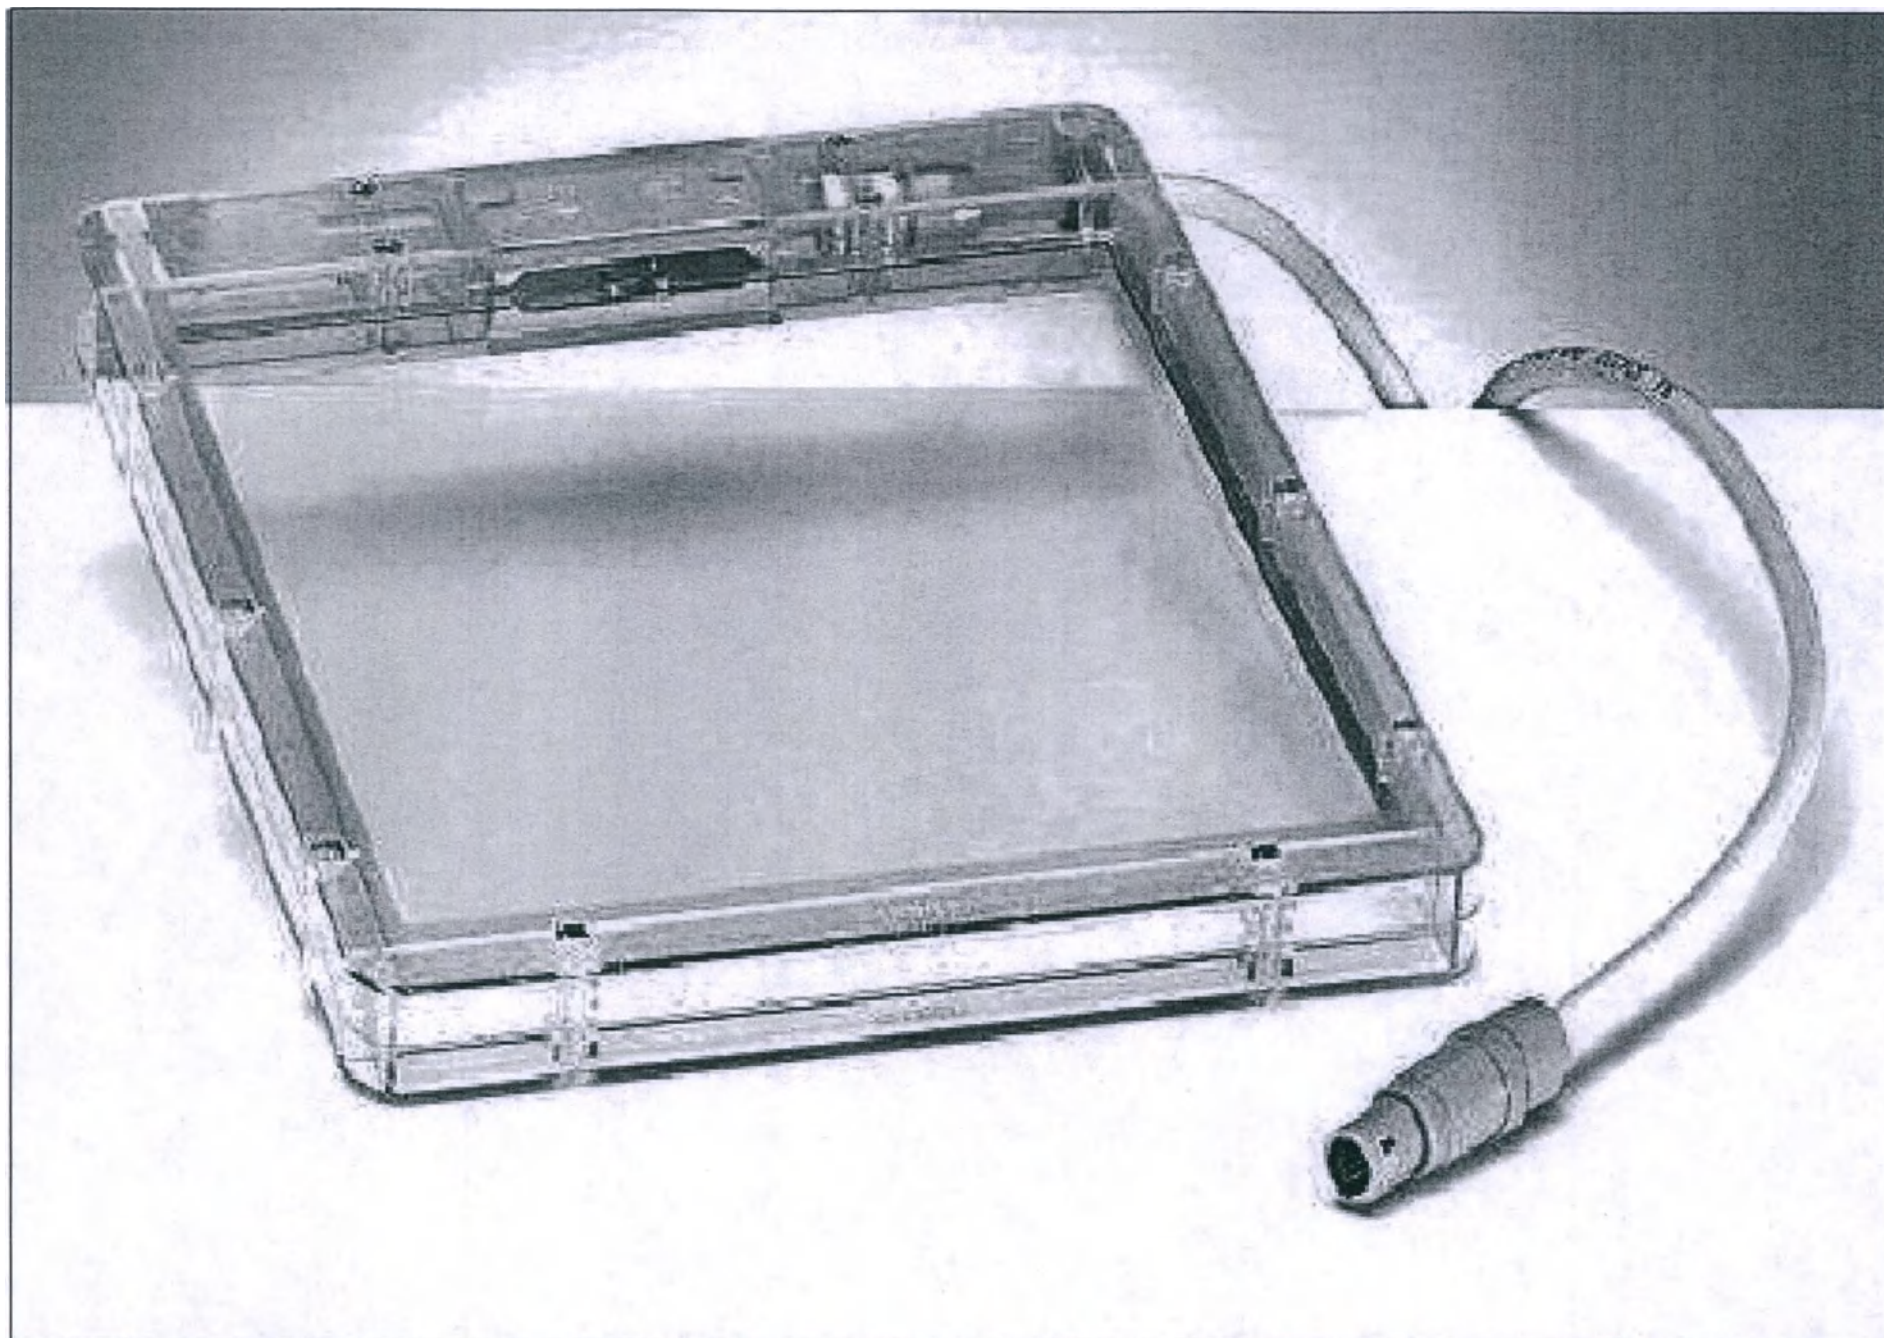


16.б. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

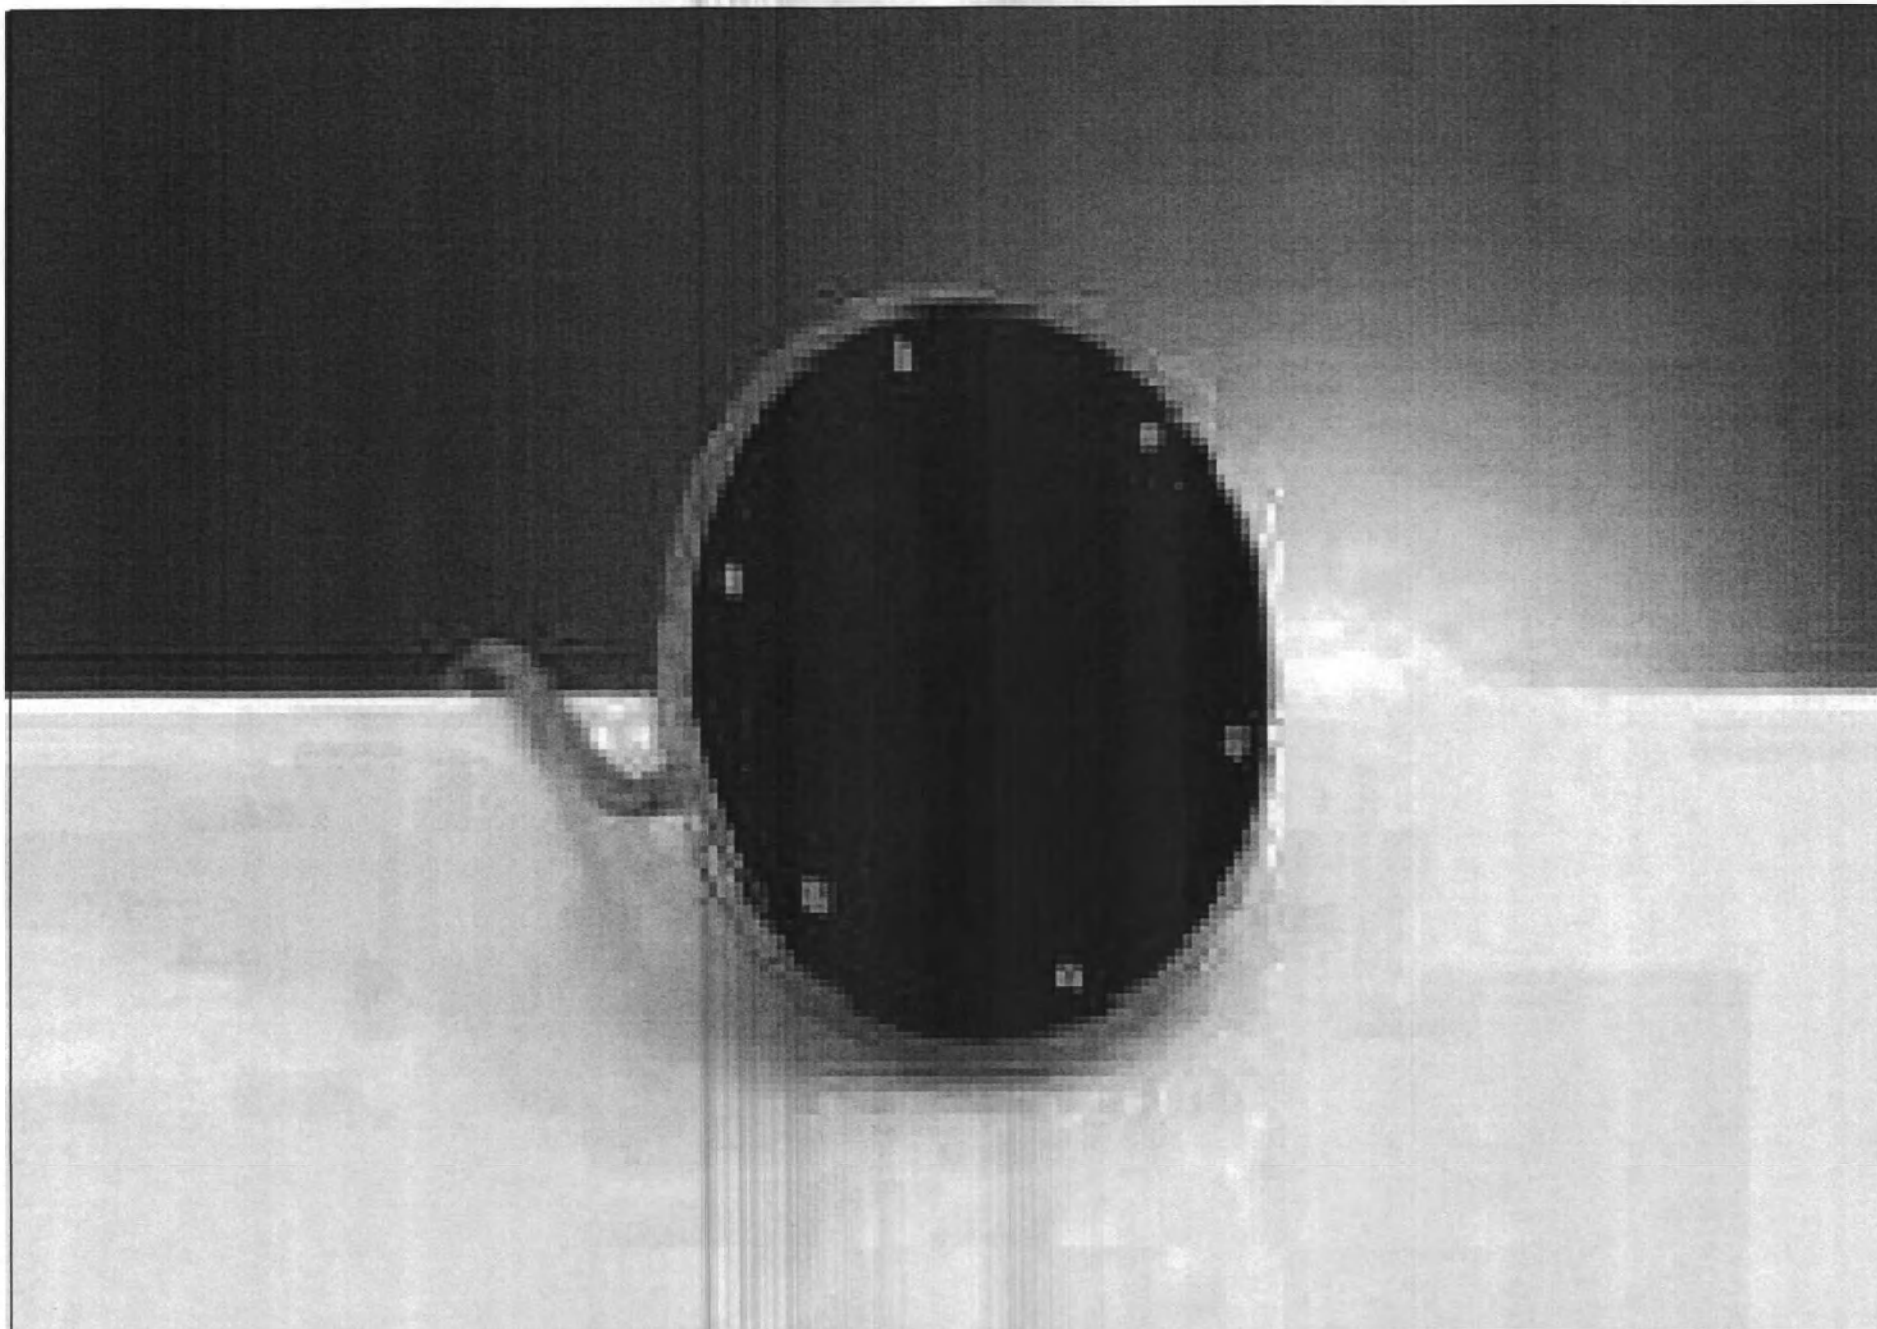


16.в. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДРК-1* или *ДРК-1М*.

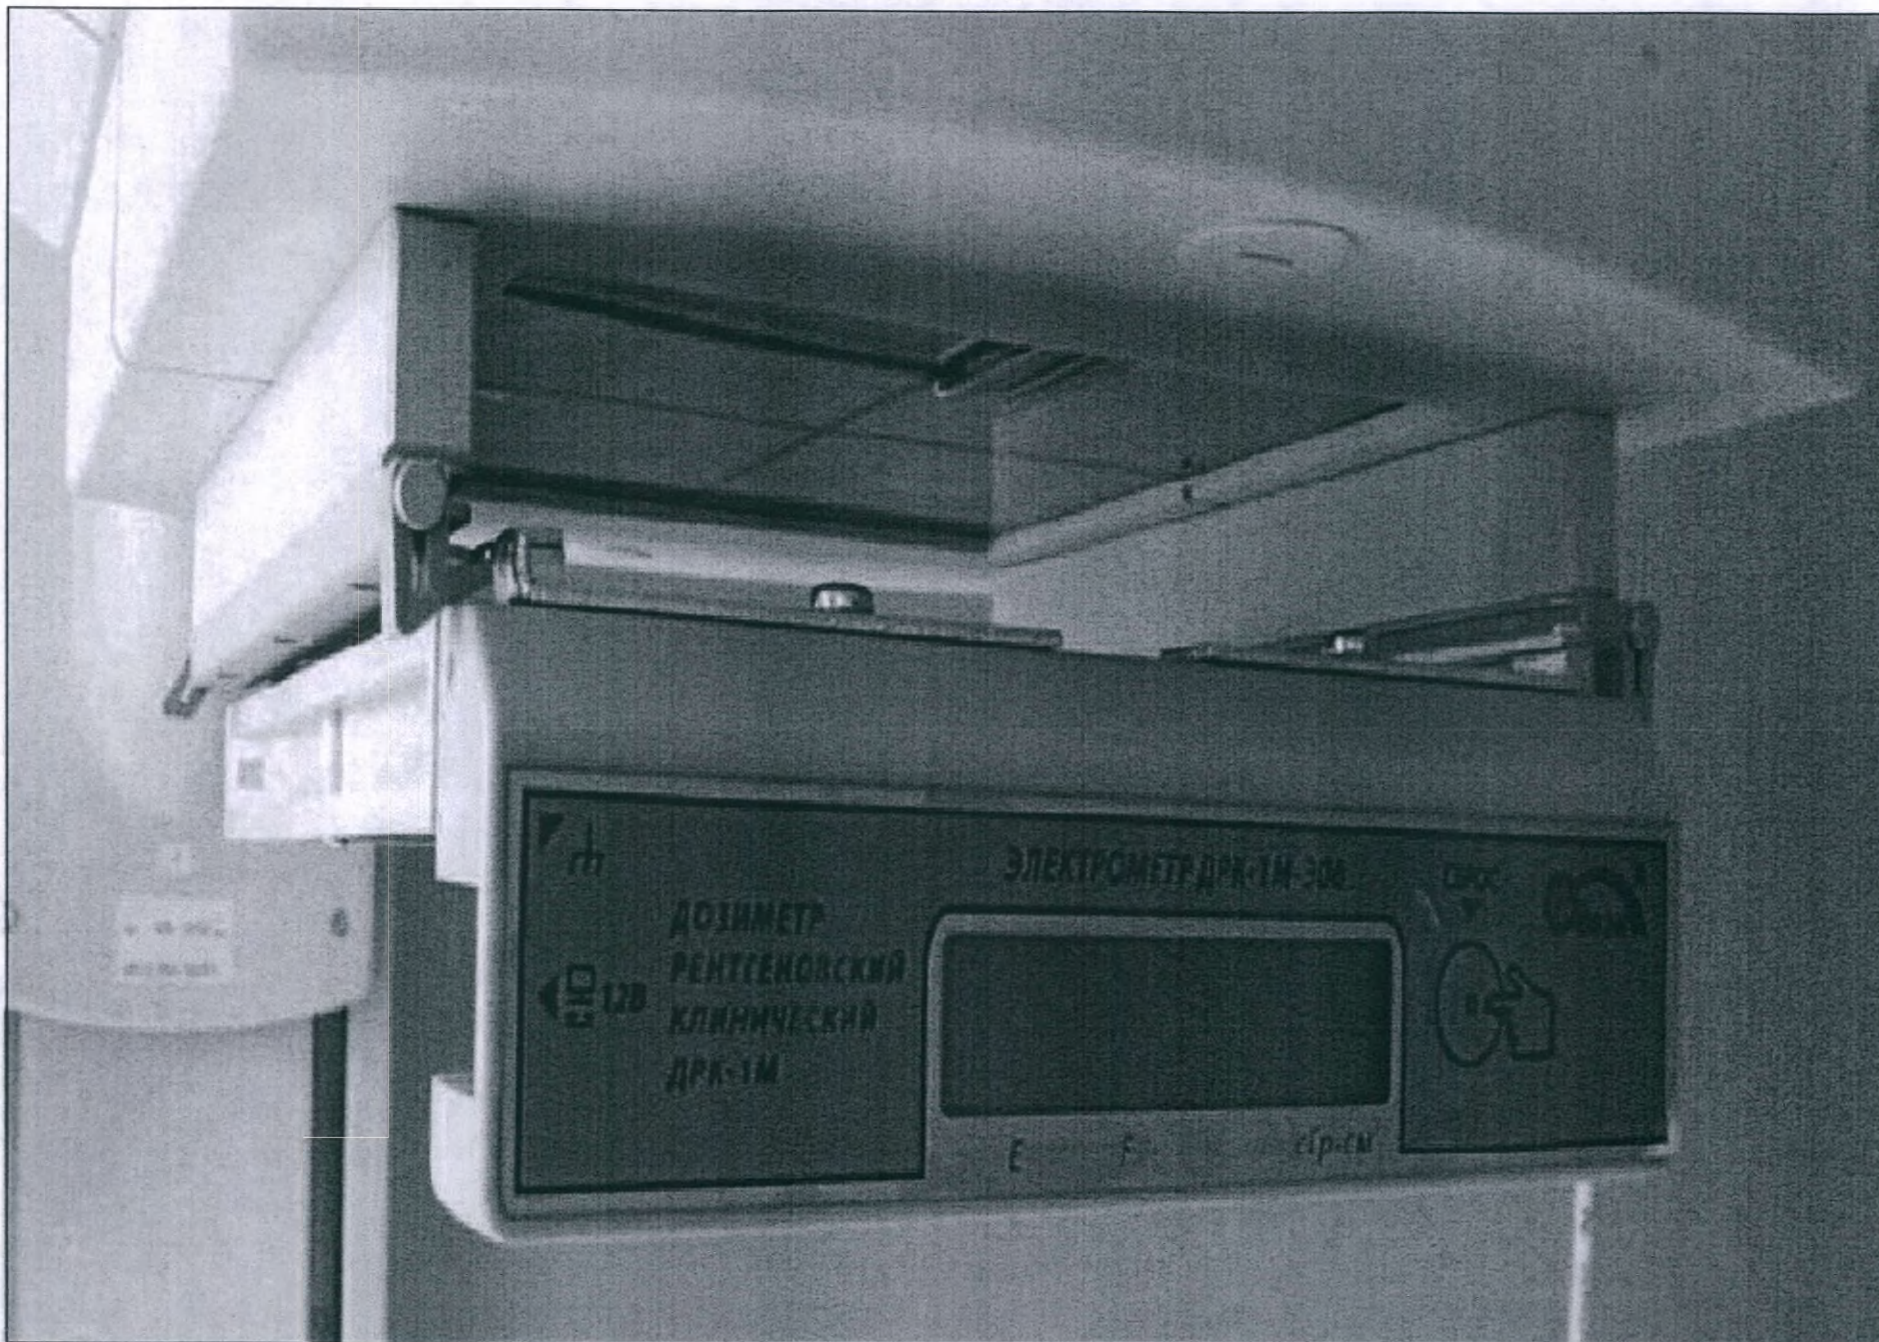


16.2. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

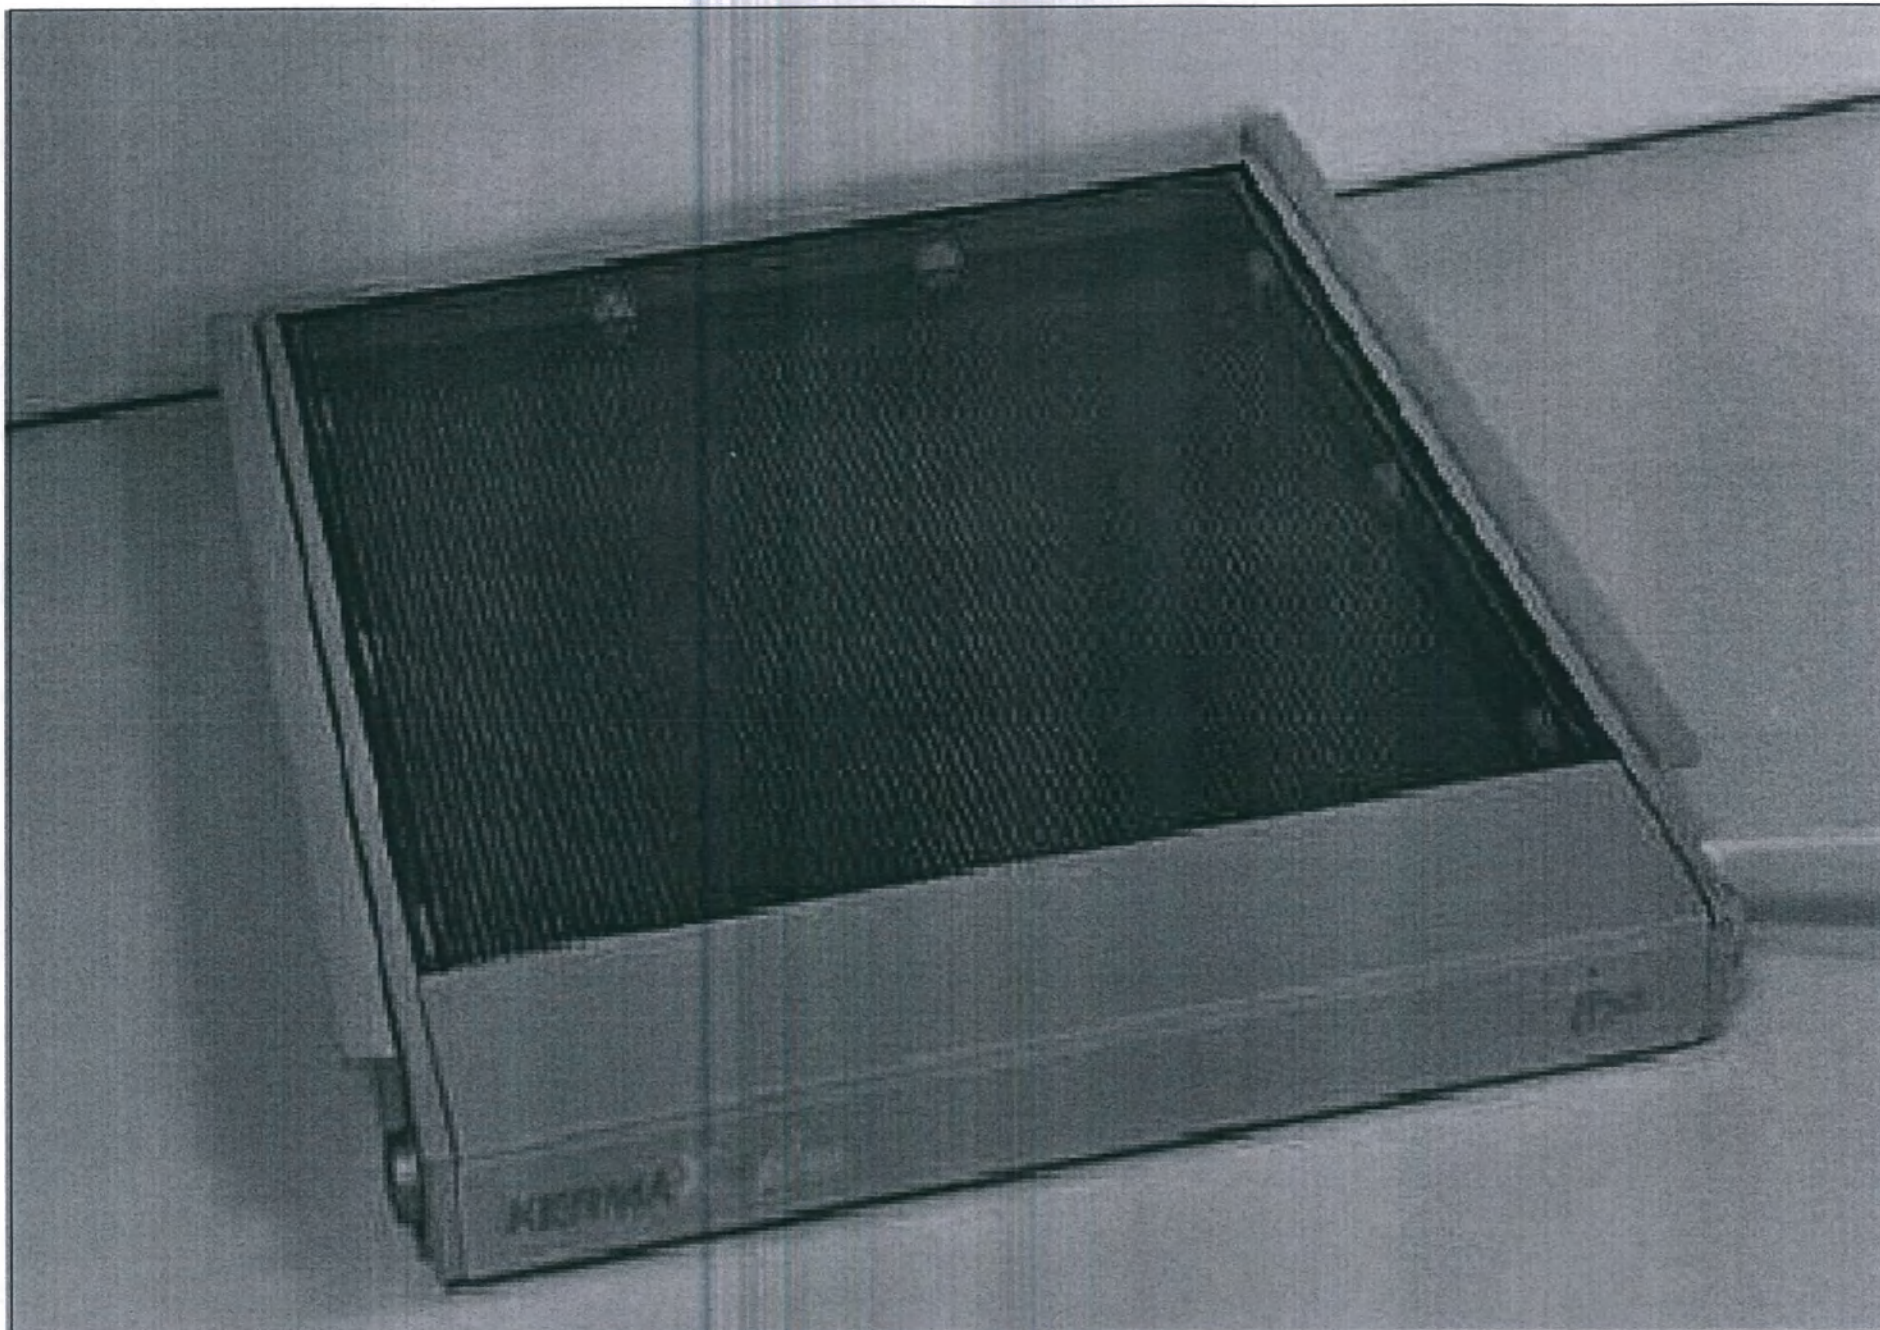


17. Измеритель производства дозы на площадь Kertax plus 120-132.

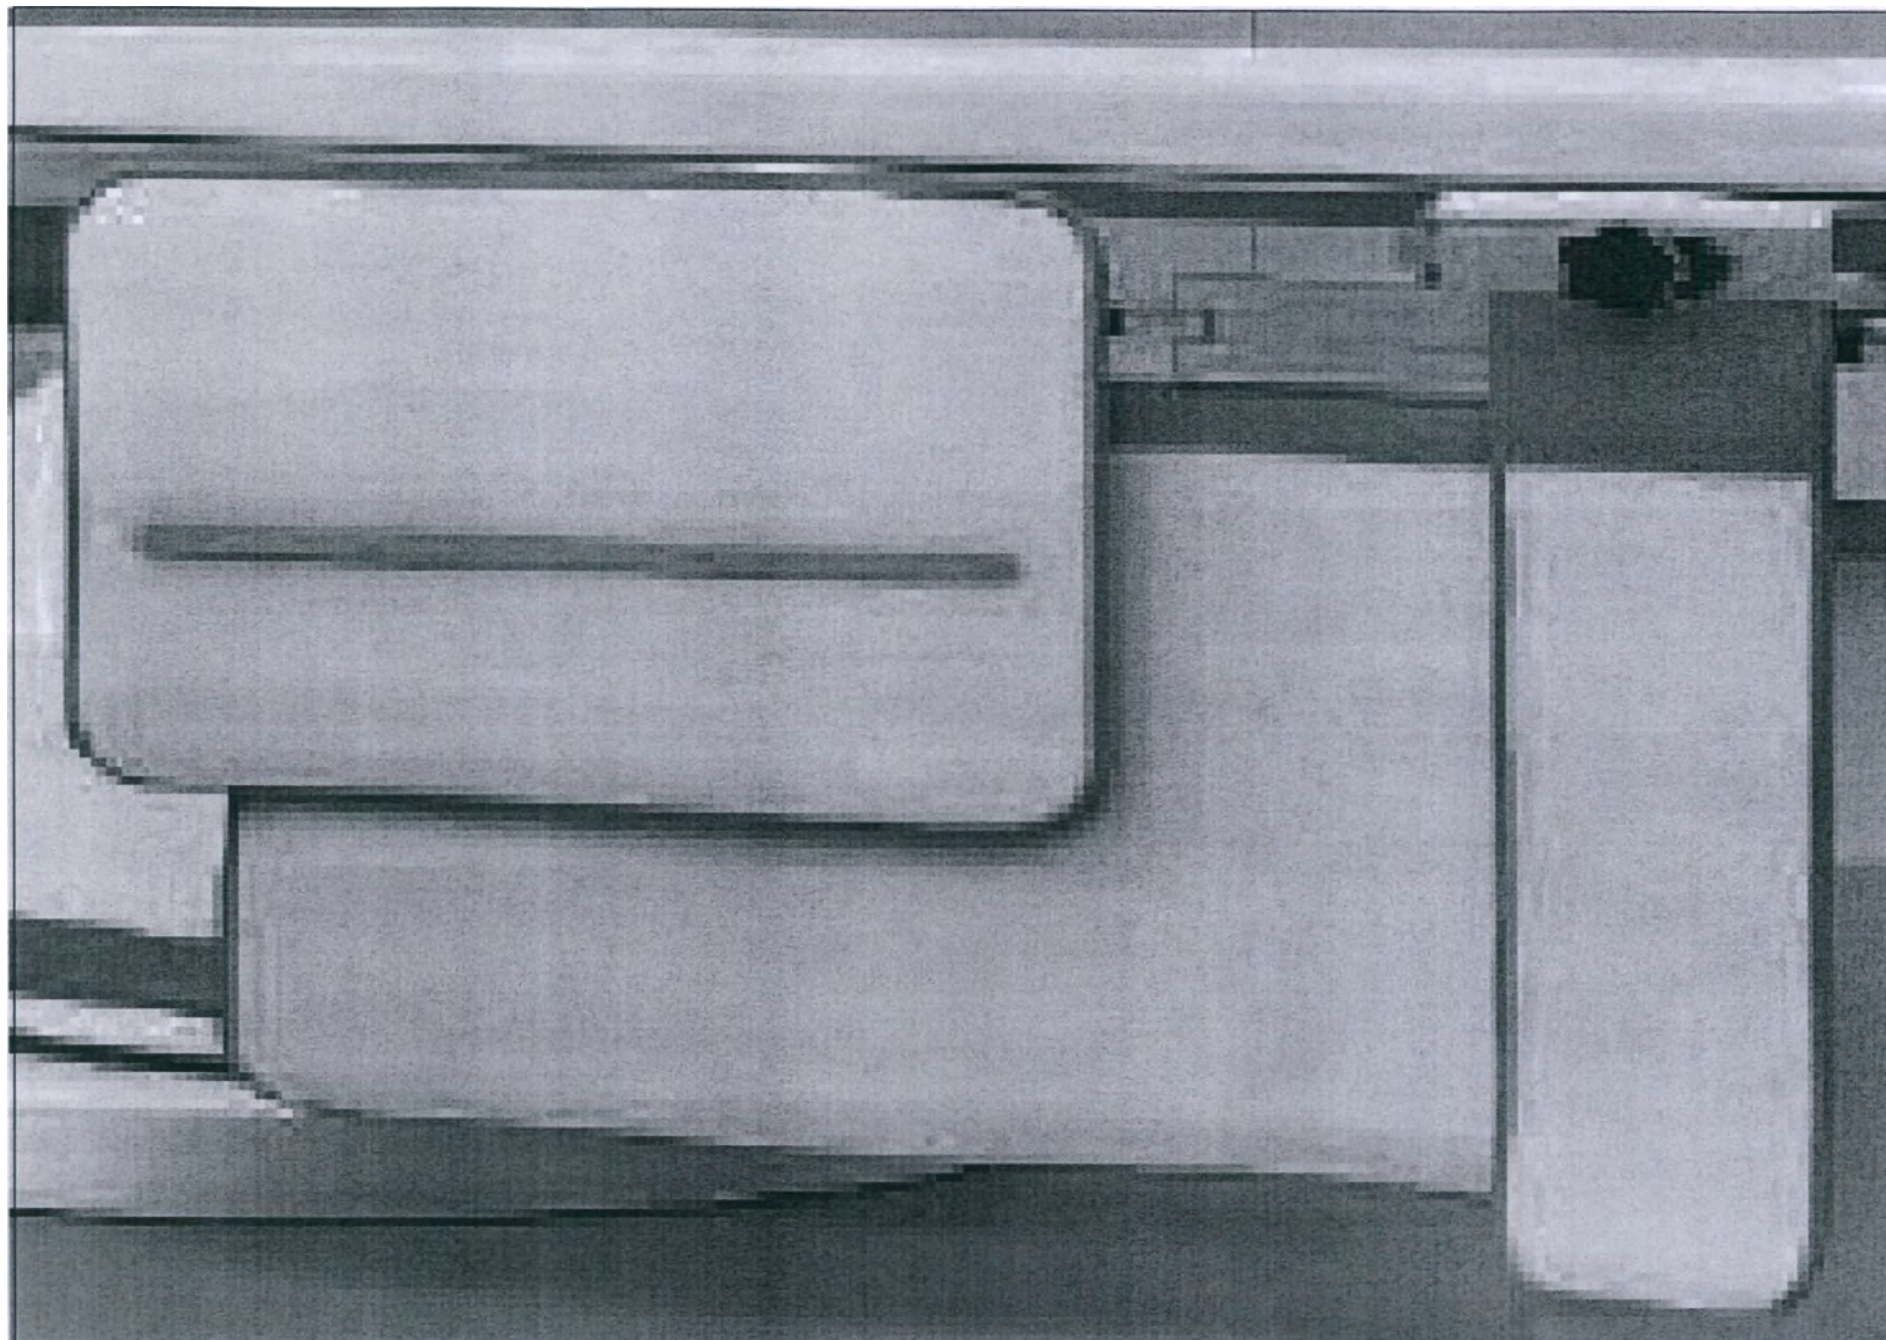


18. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

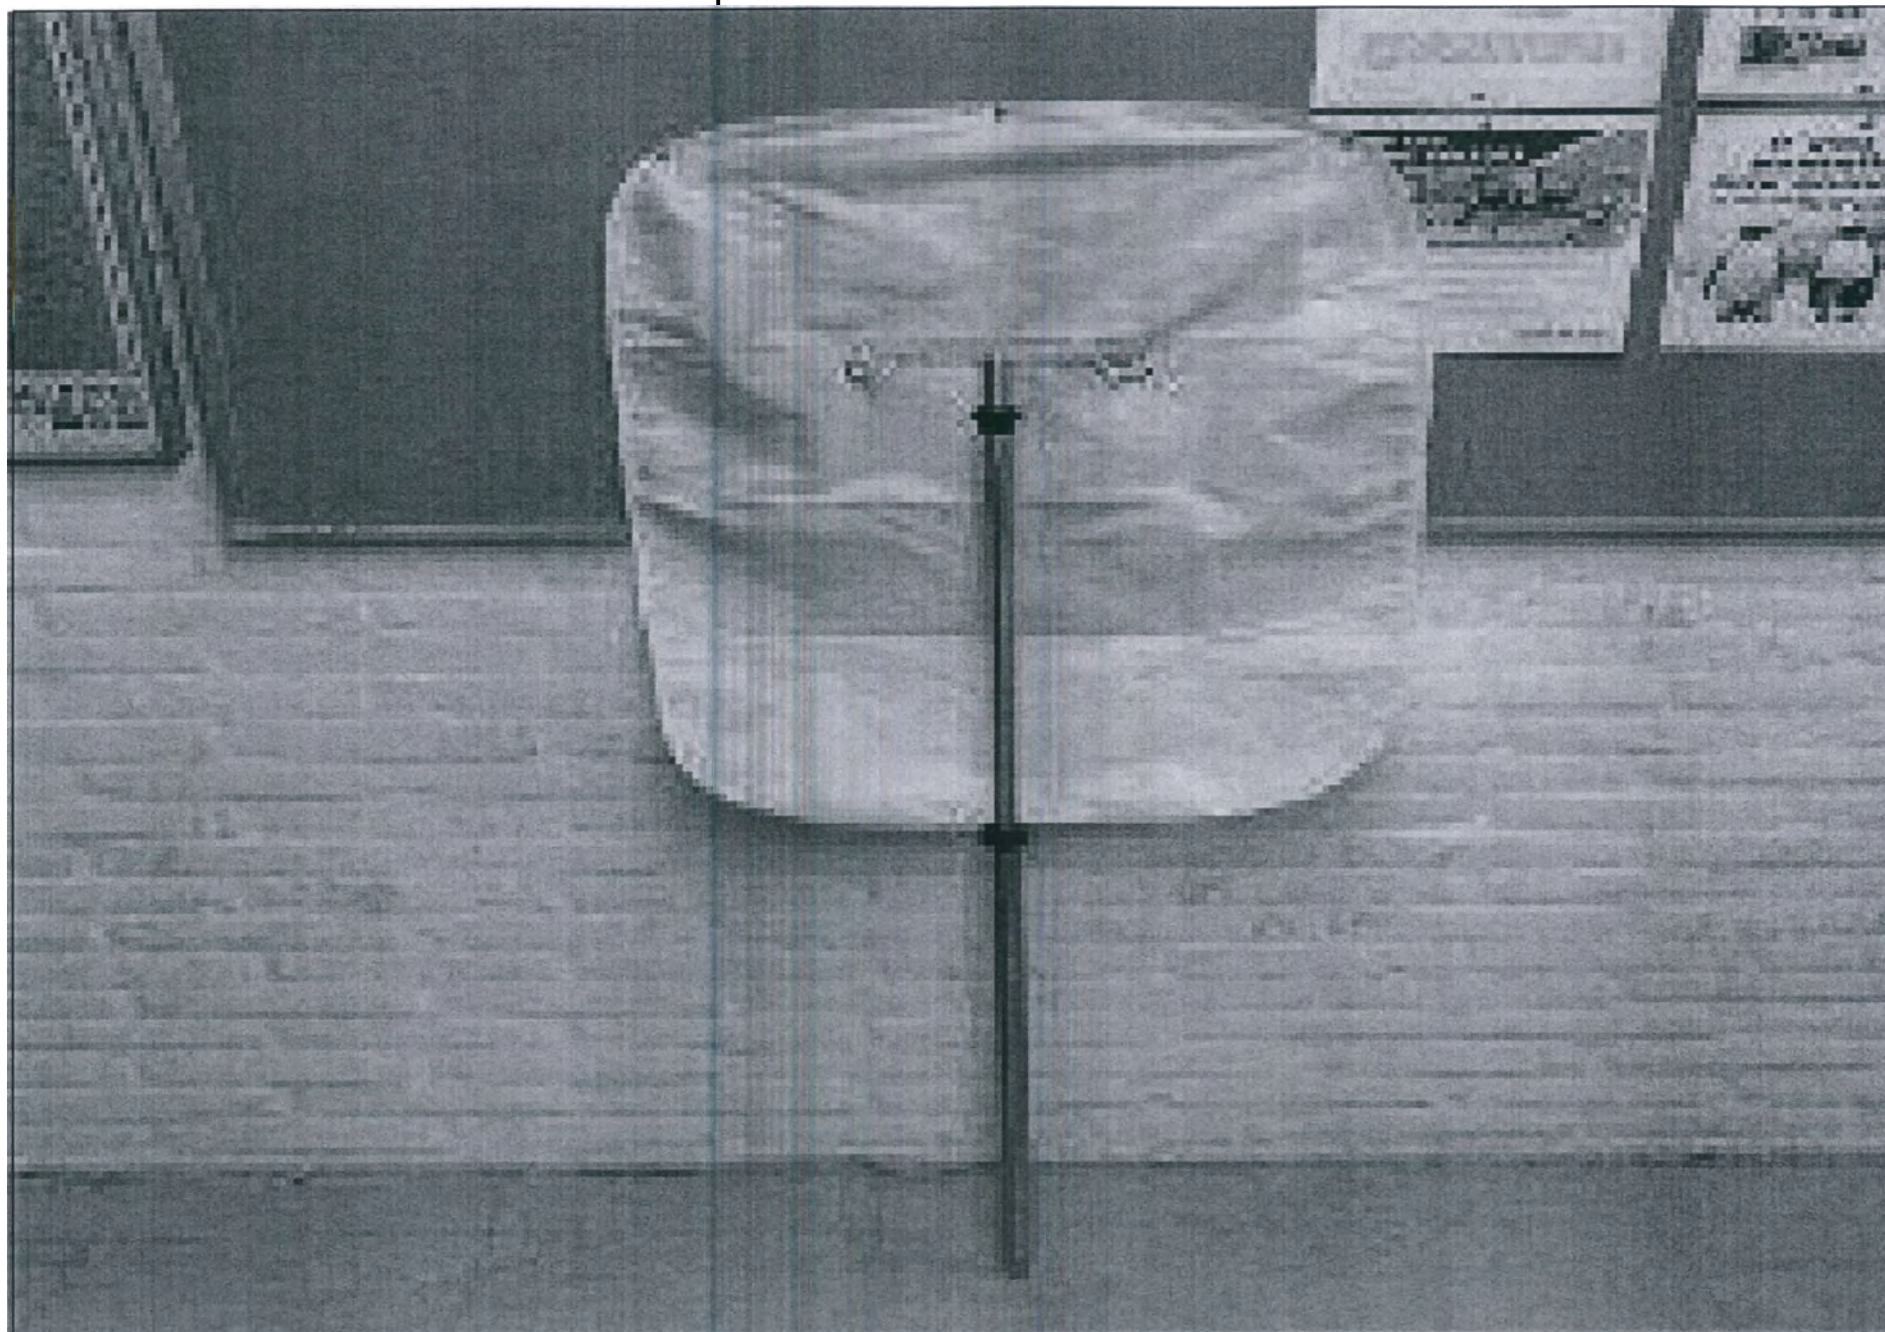


19. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

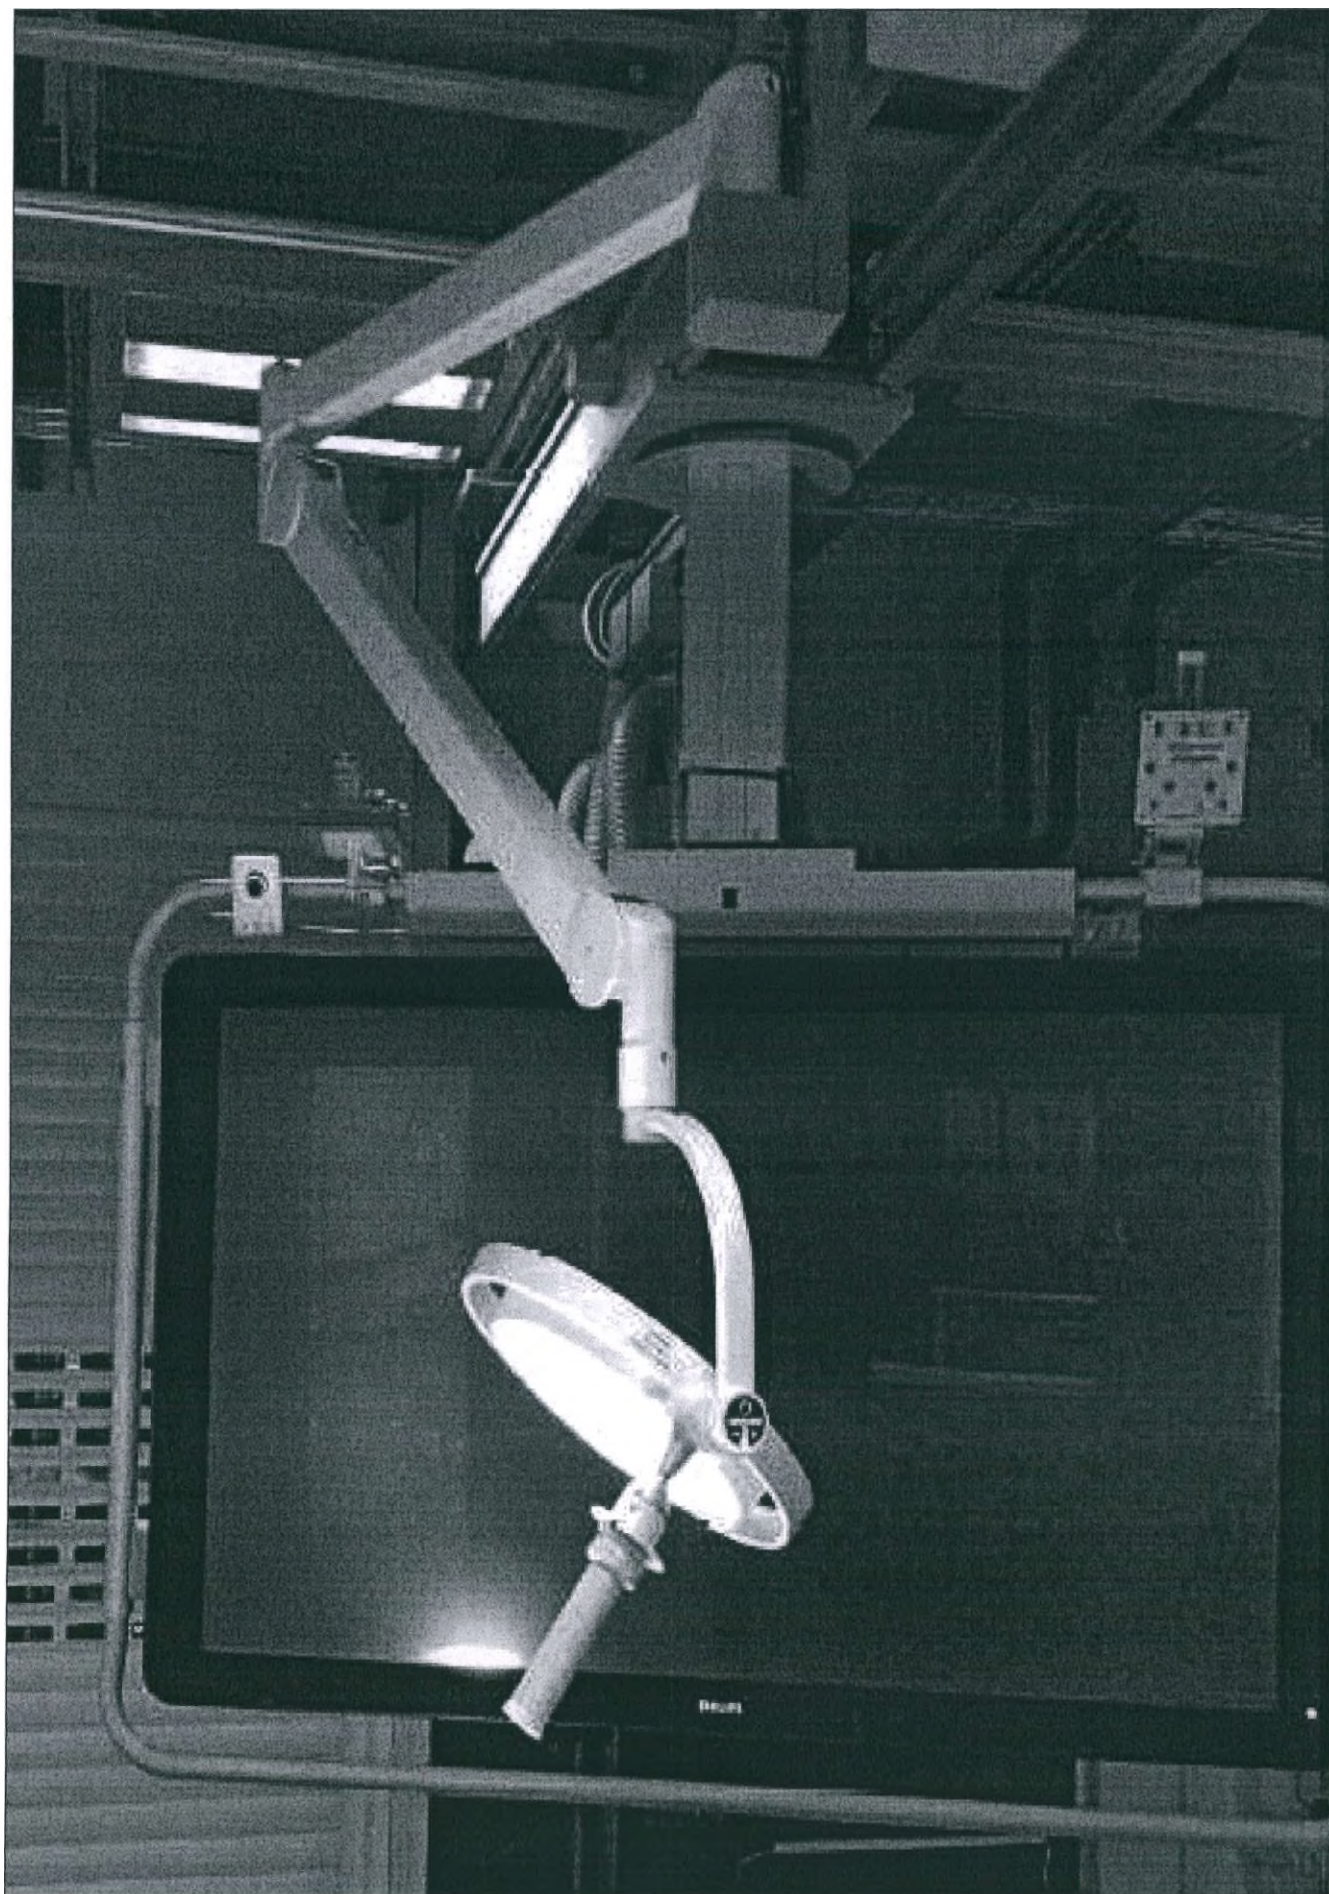

20. Лампа для осмотра

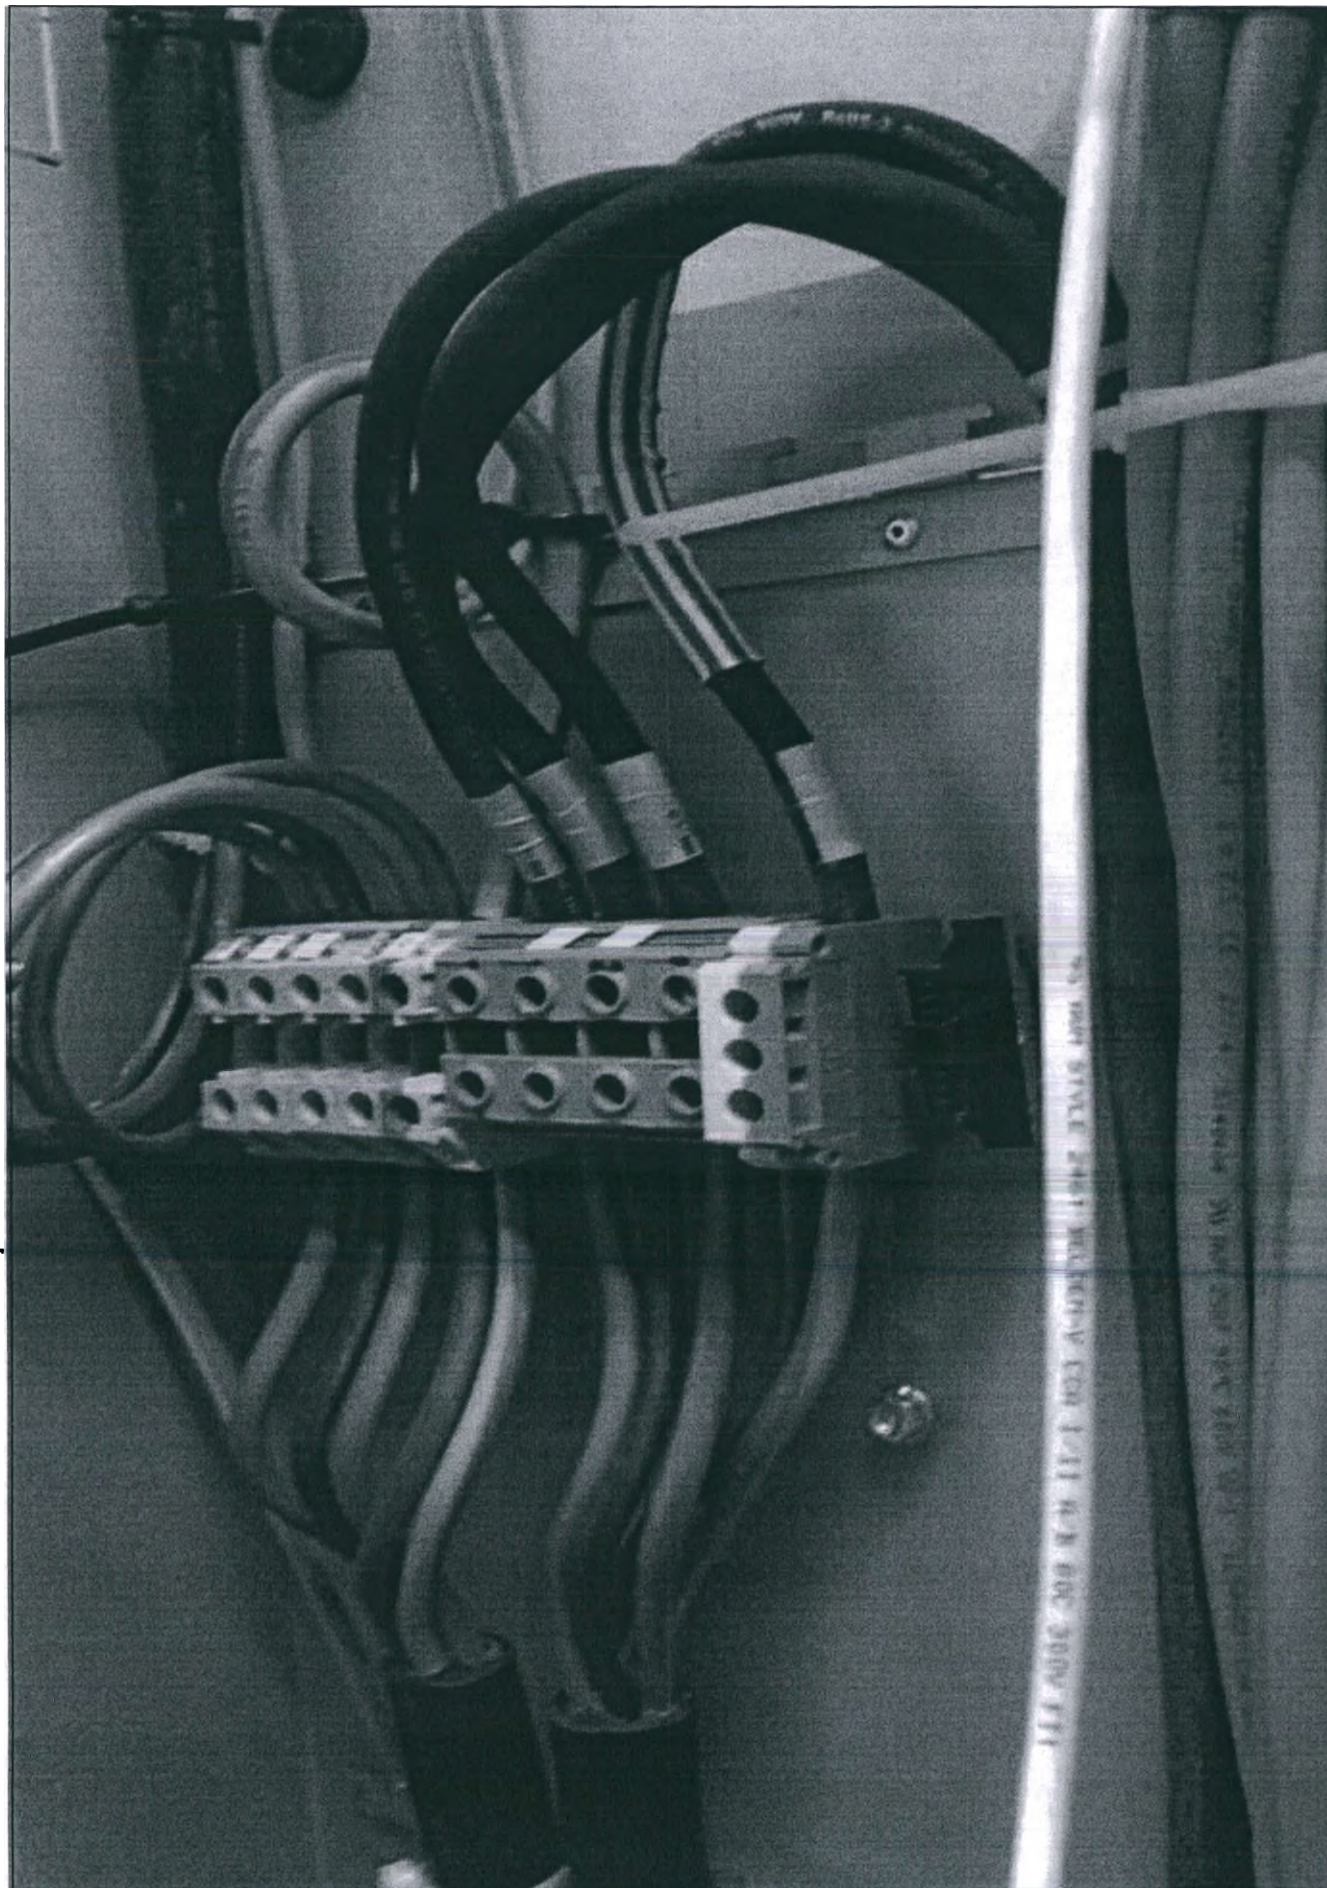

21. Кабели питания, 10 шт.

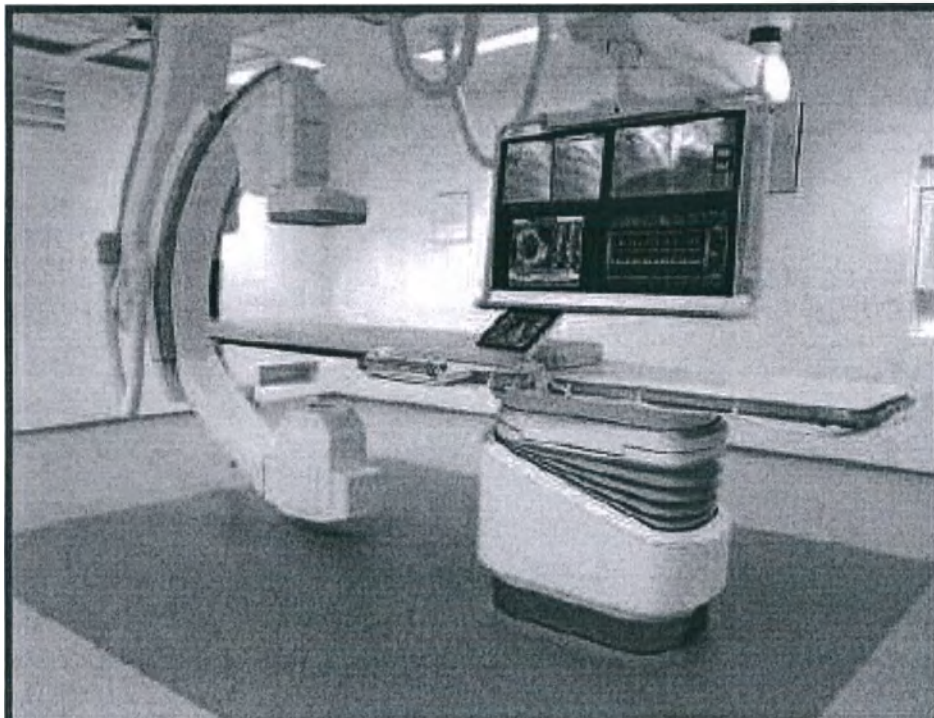

Руководство по
эксплуатации

Русский

4522 203 52651


Azurion

Версия 1.2


PHILIPS

22. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 7 B20 (вариант 2):

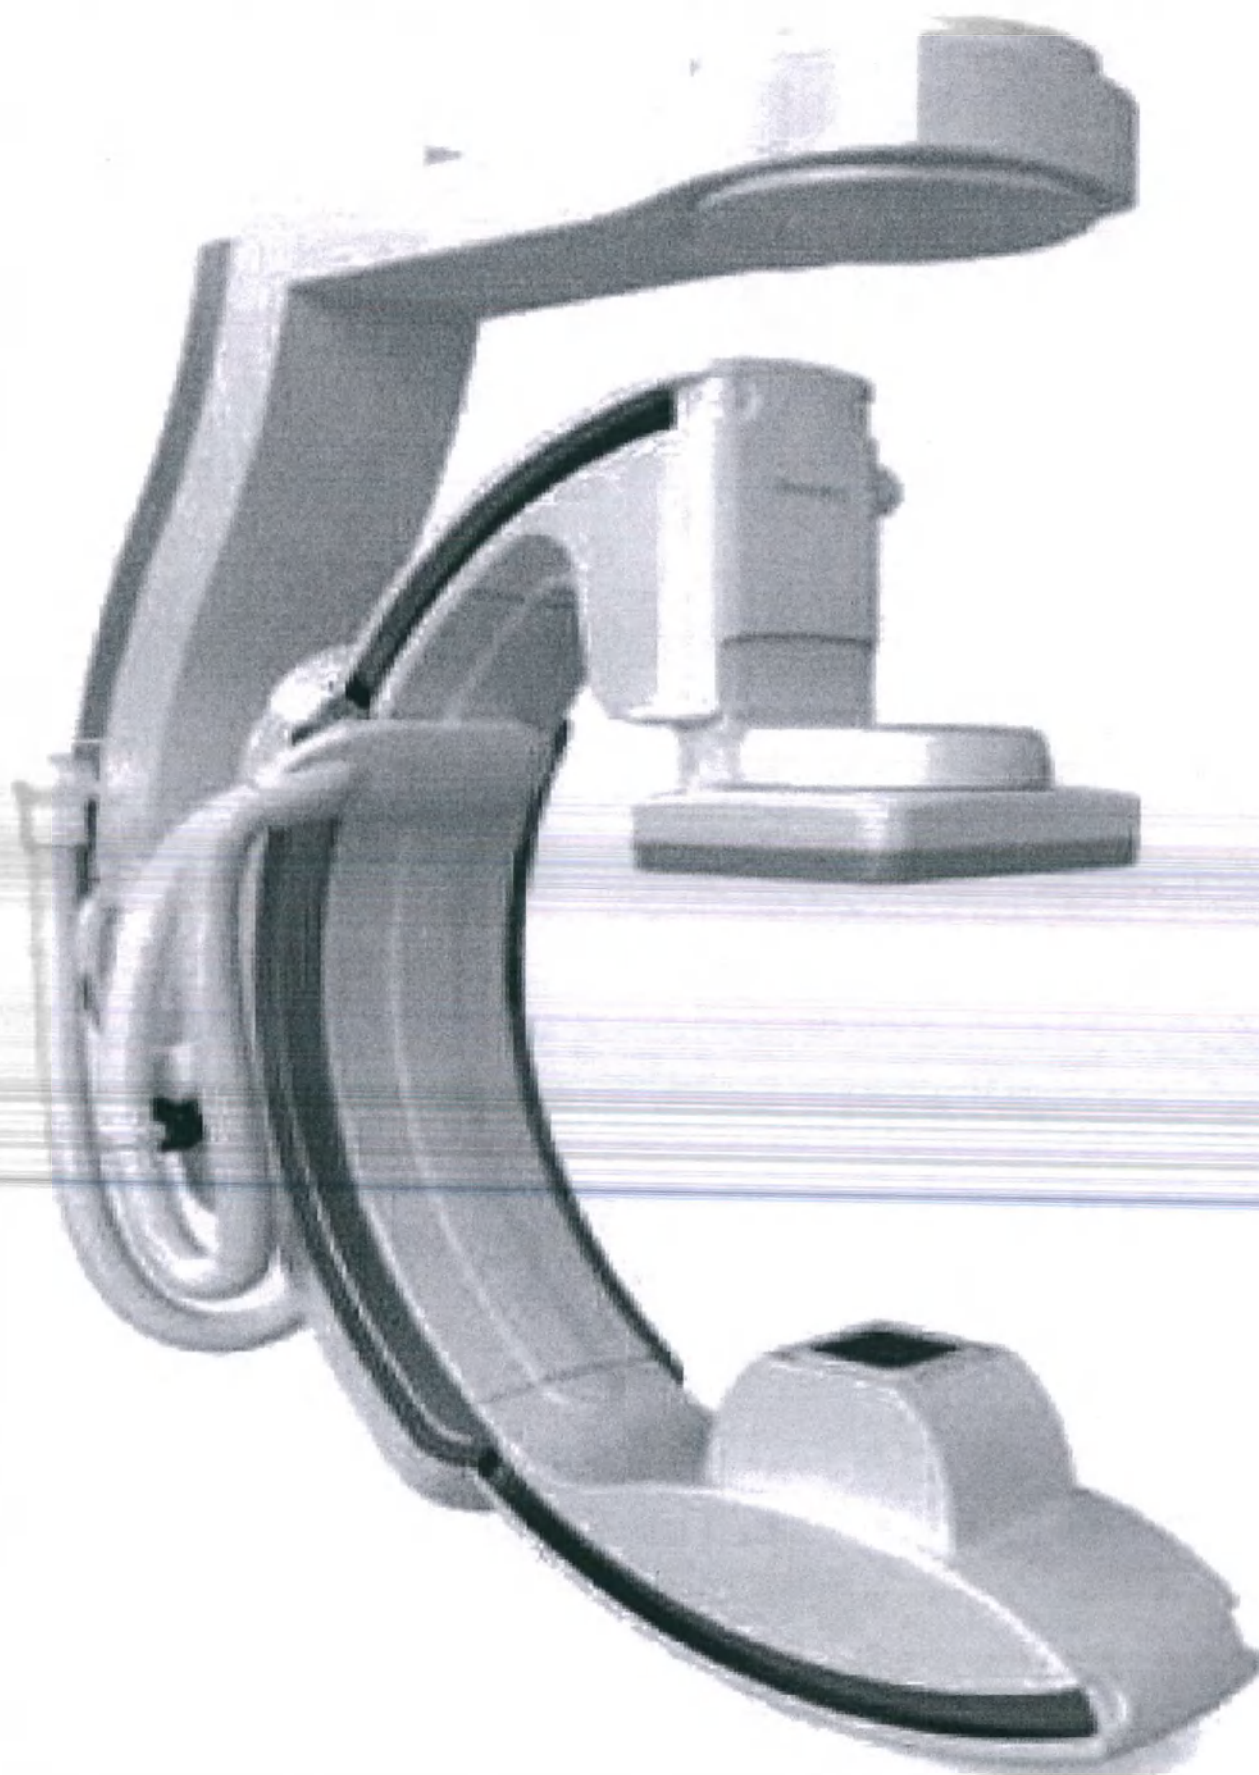

1. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

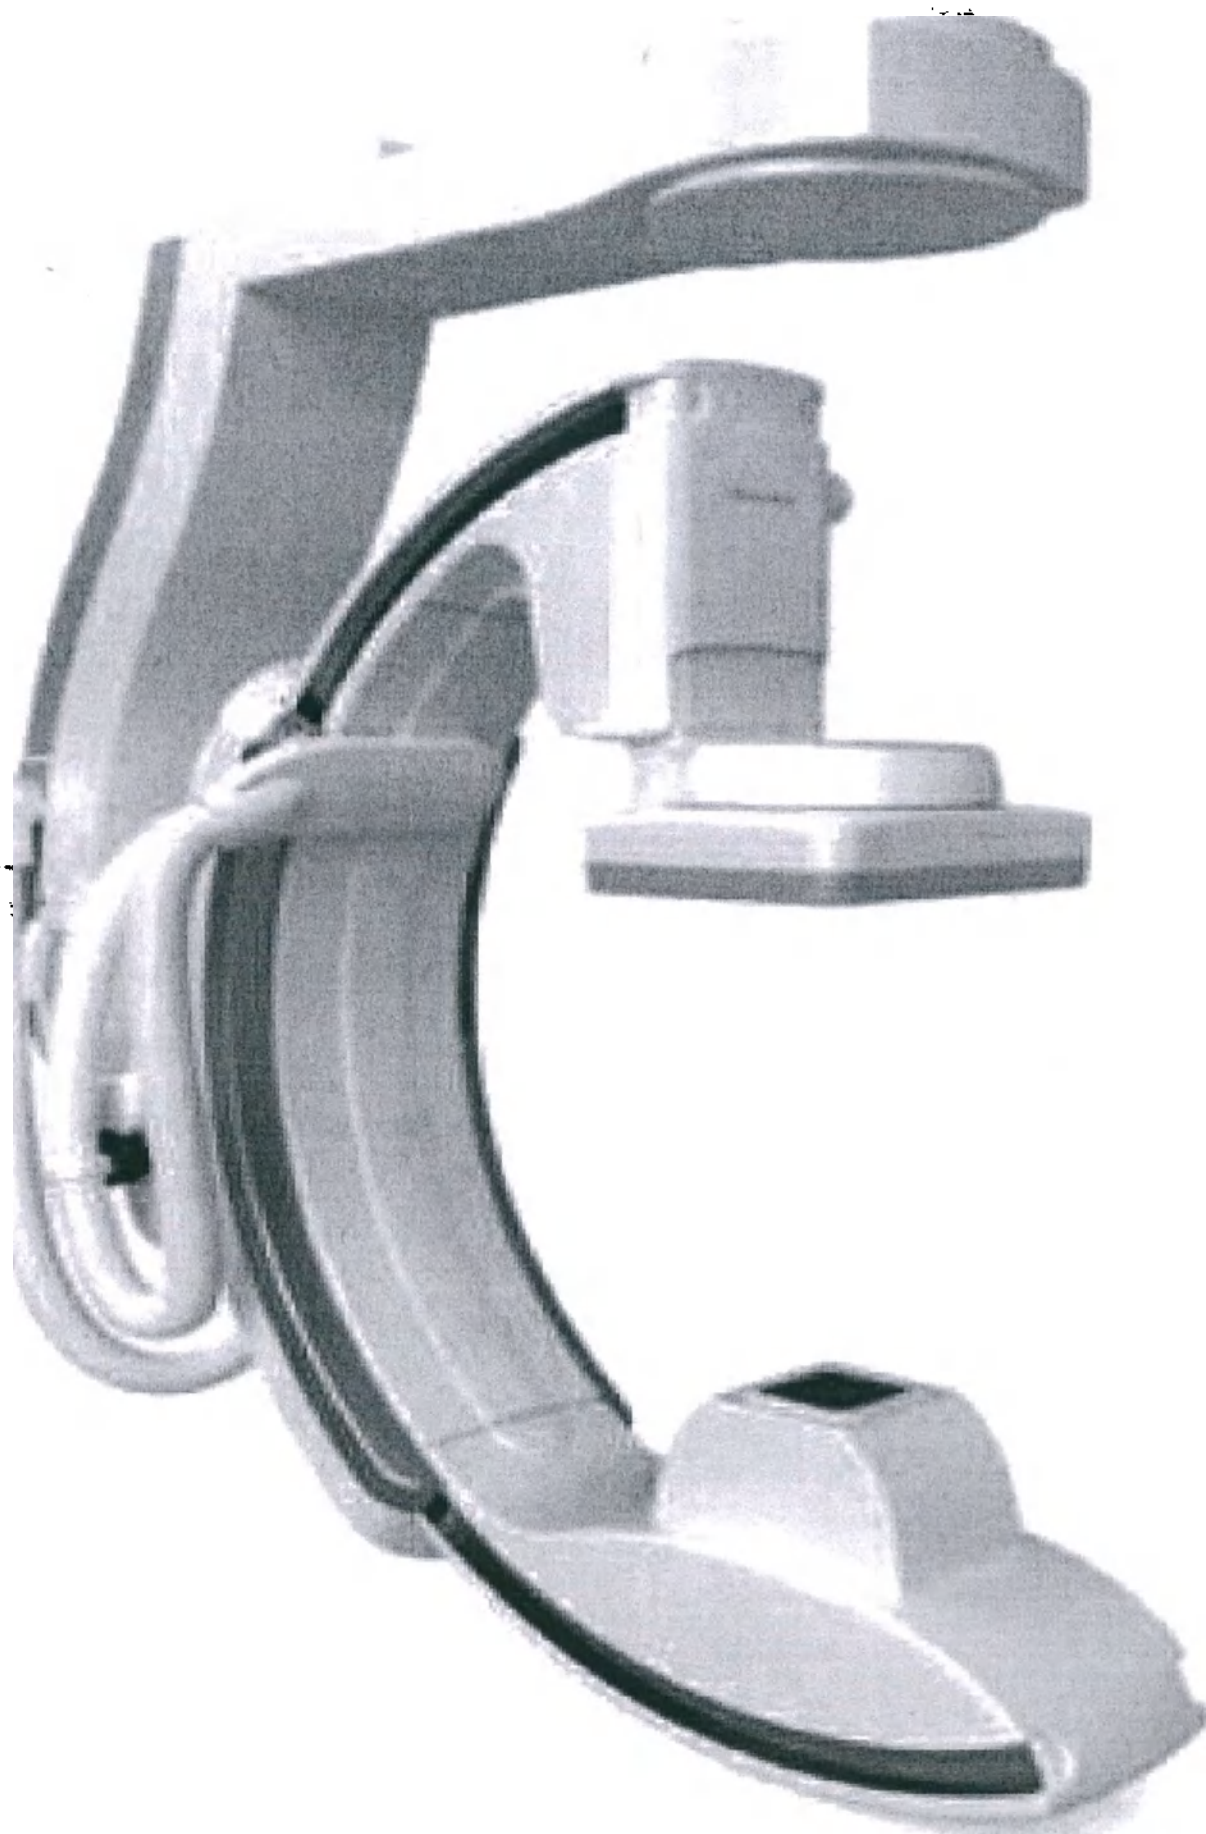


1.а. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

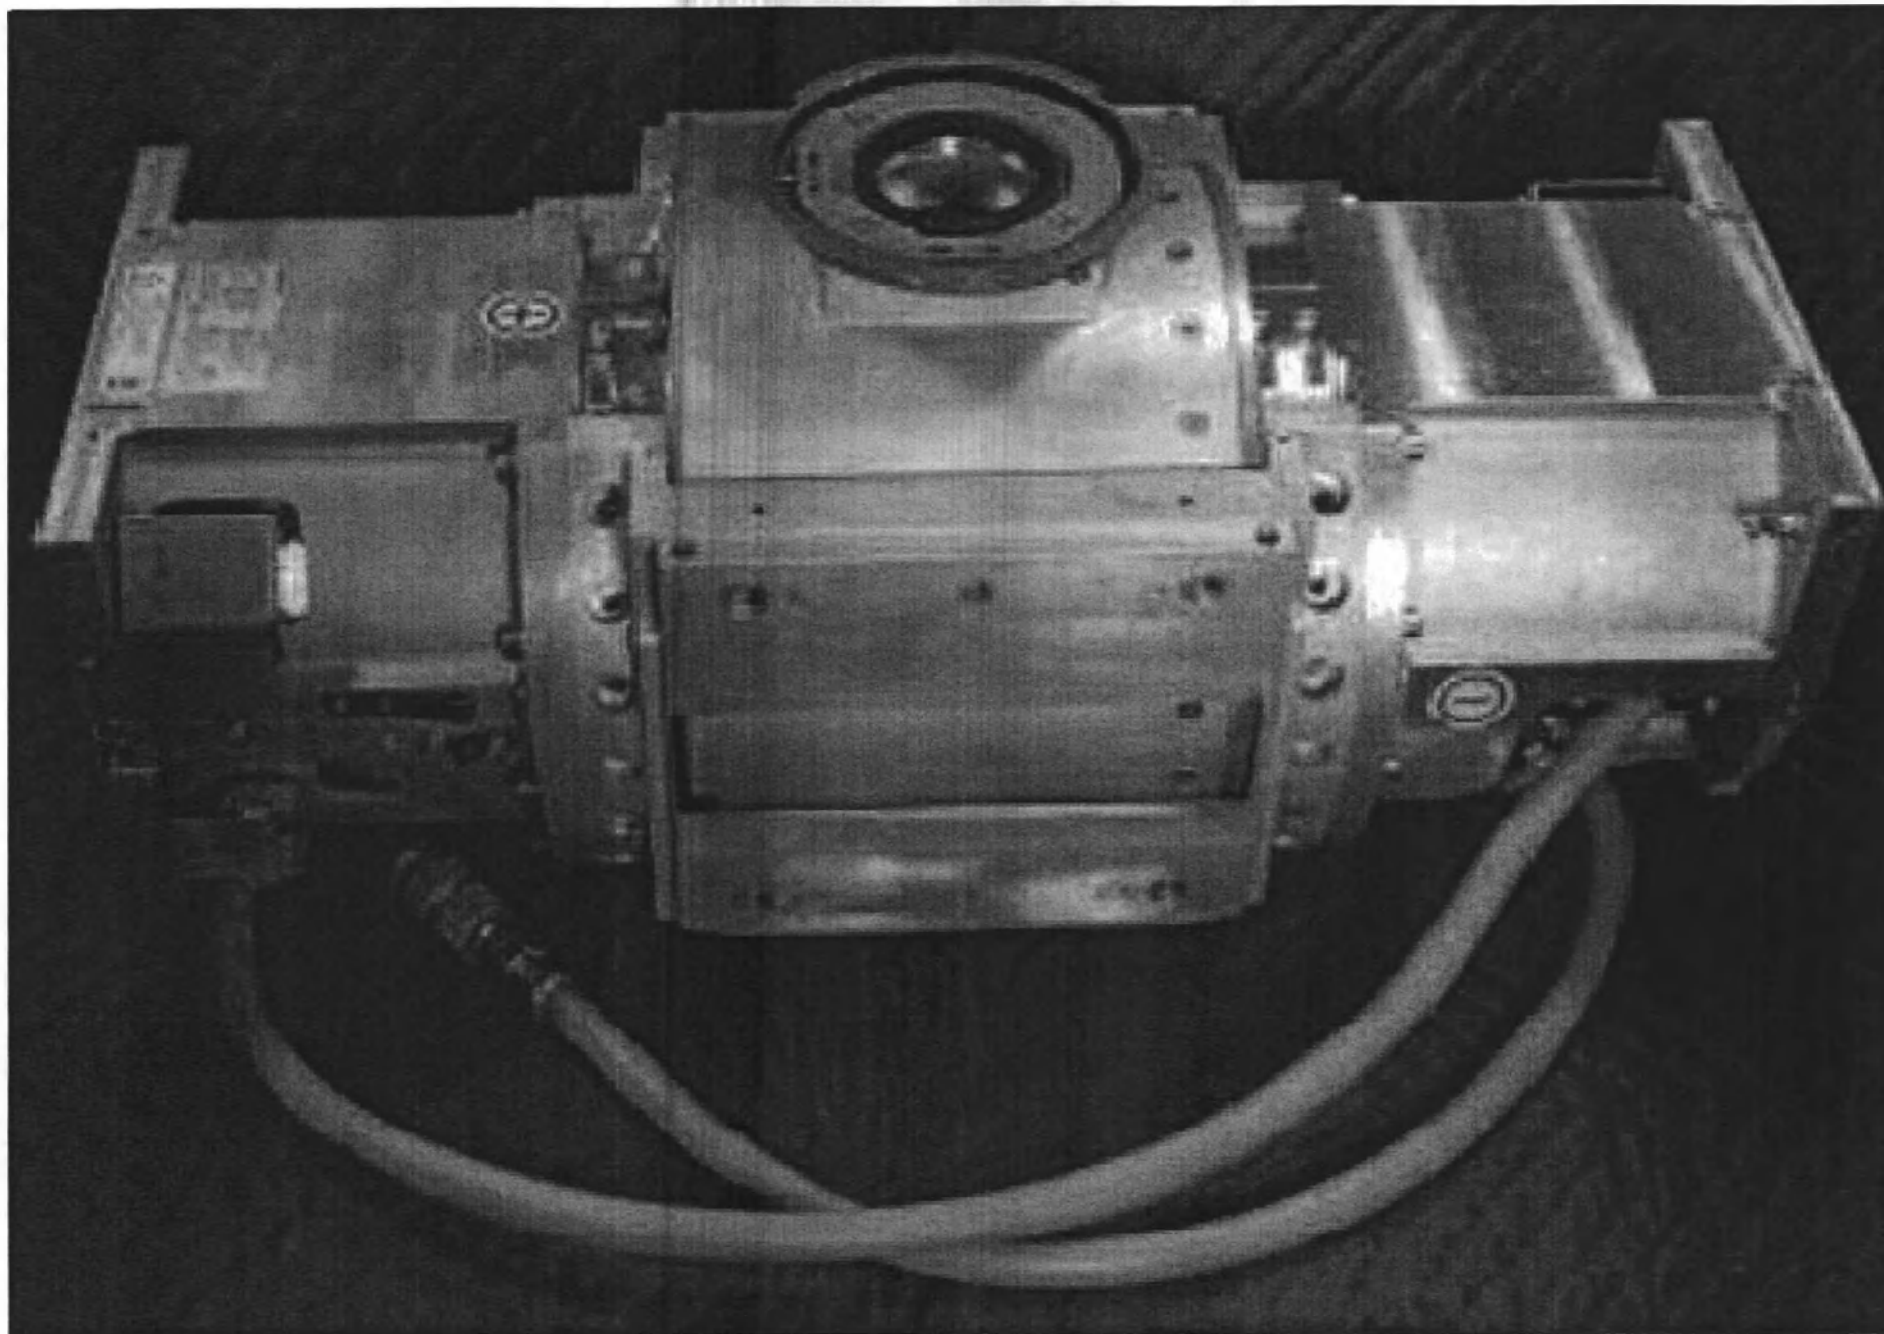


1.6. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.




1.в. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

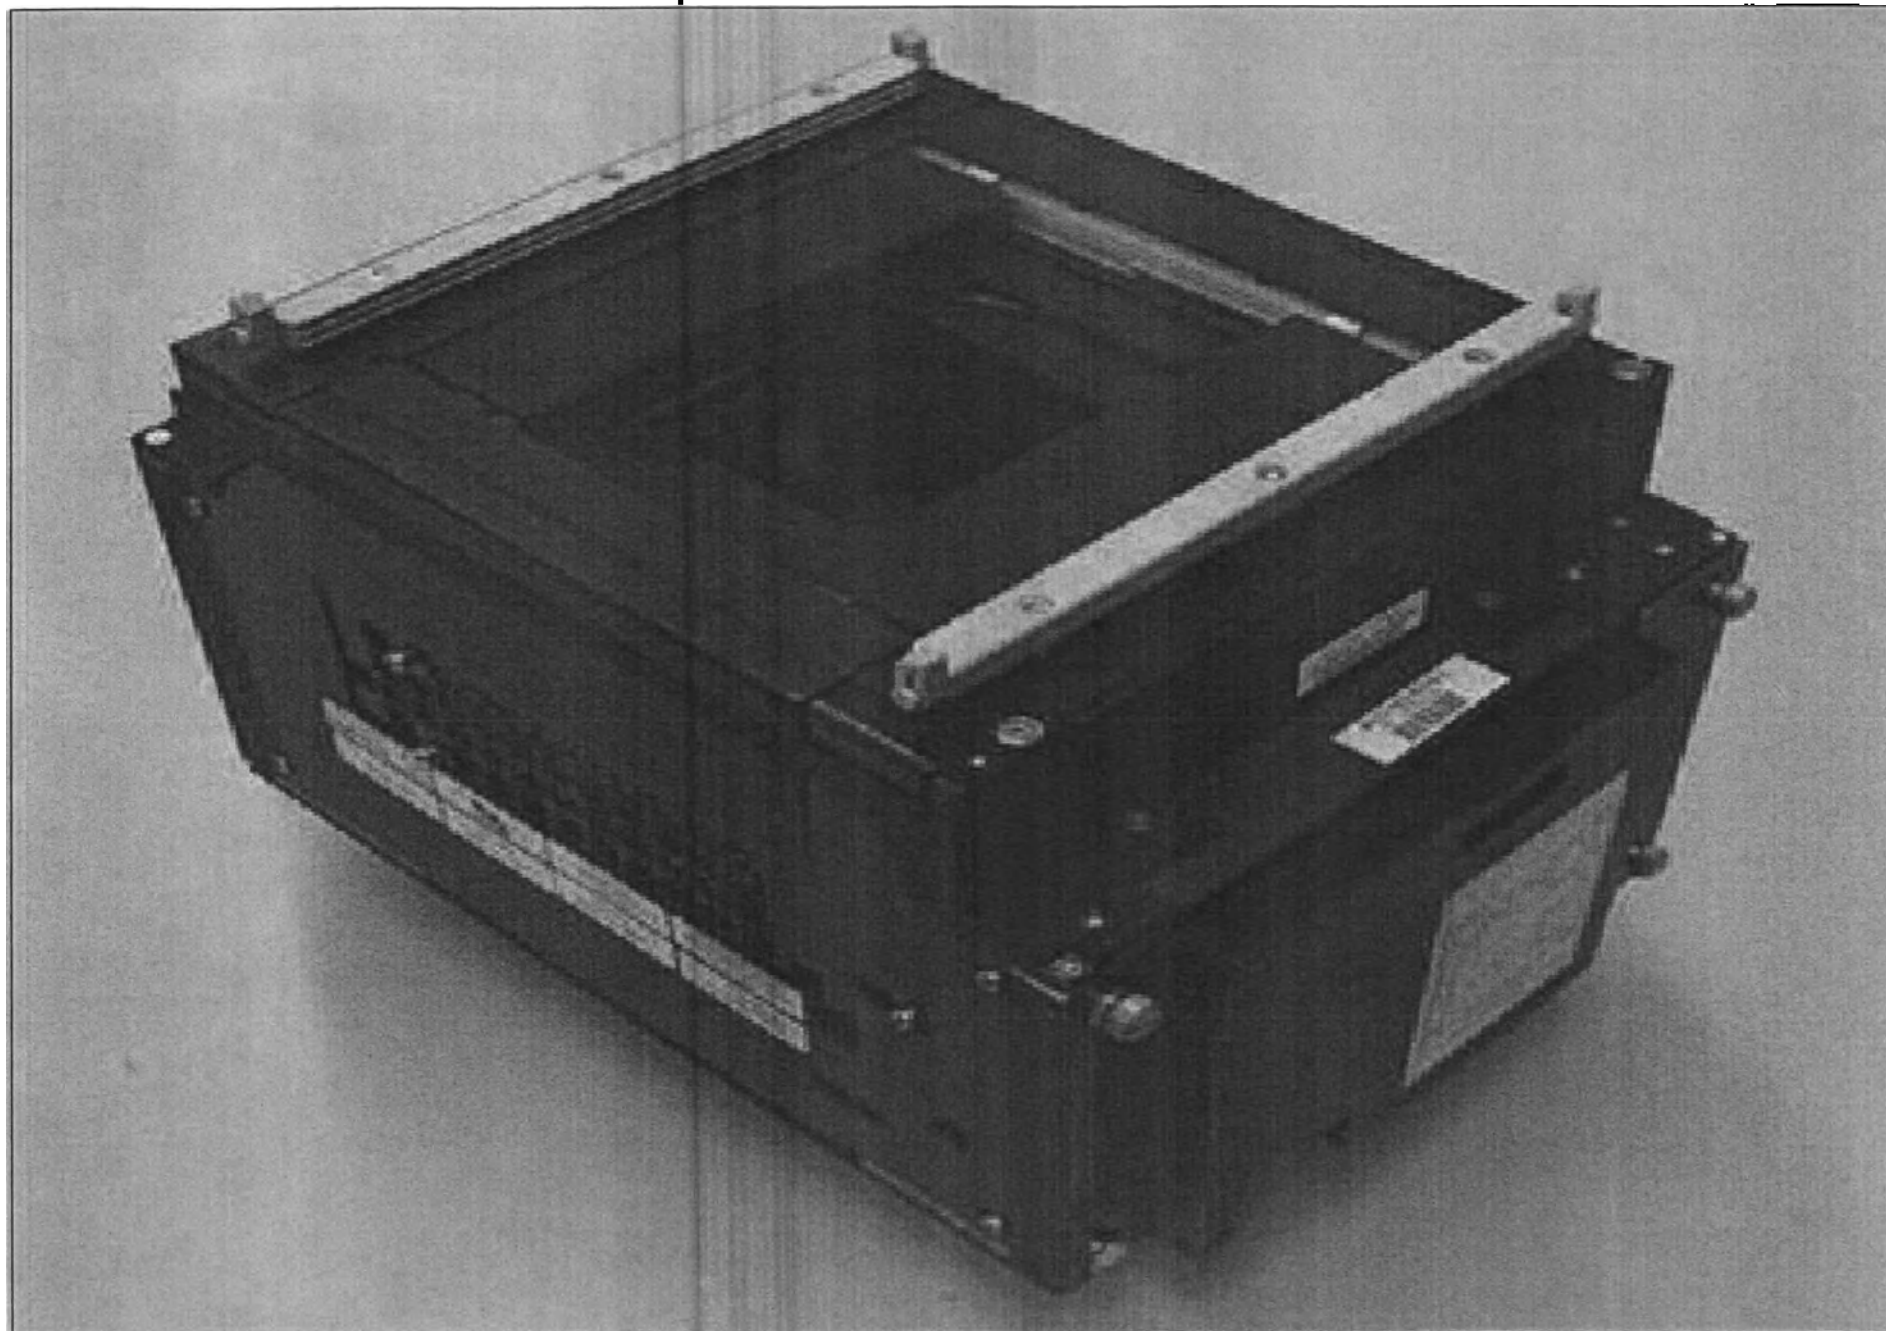

1.2. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

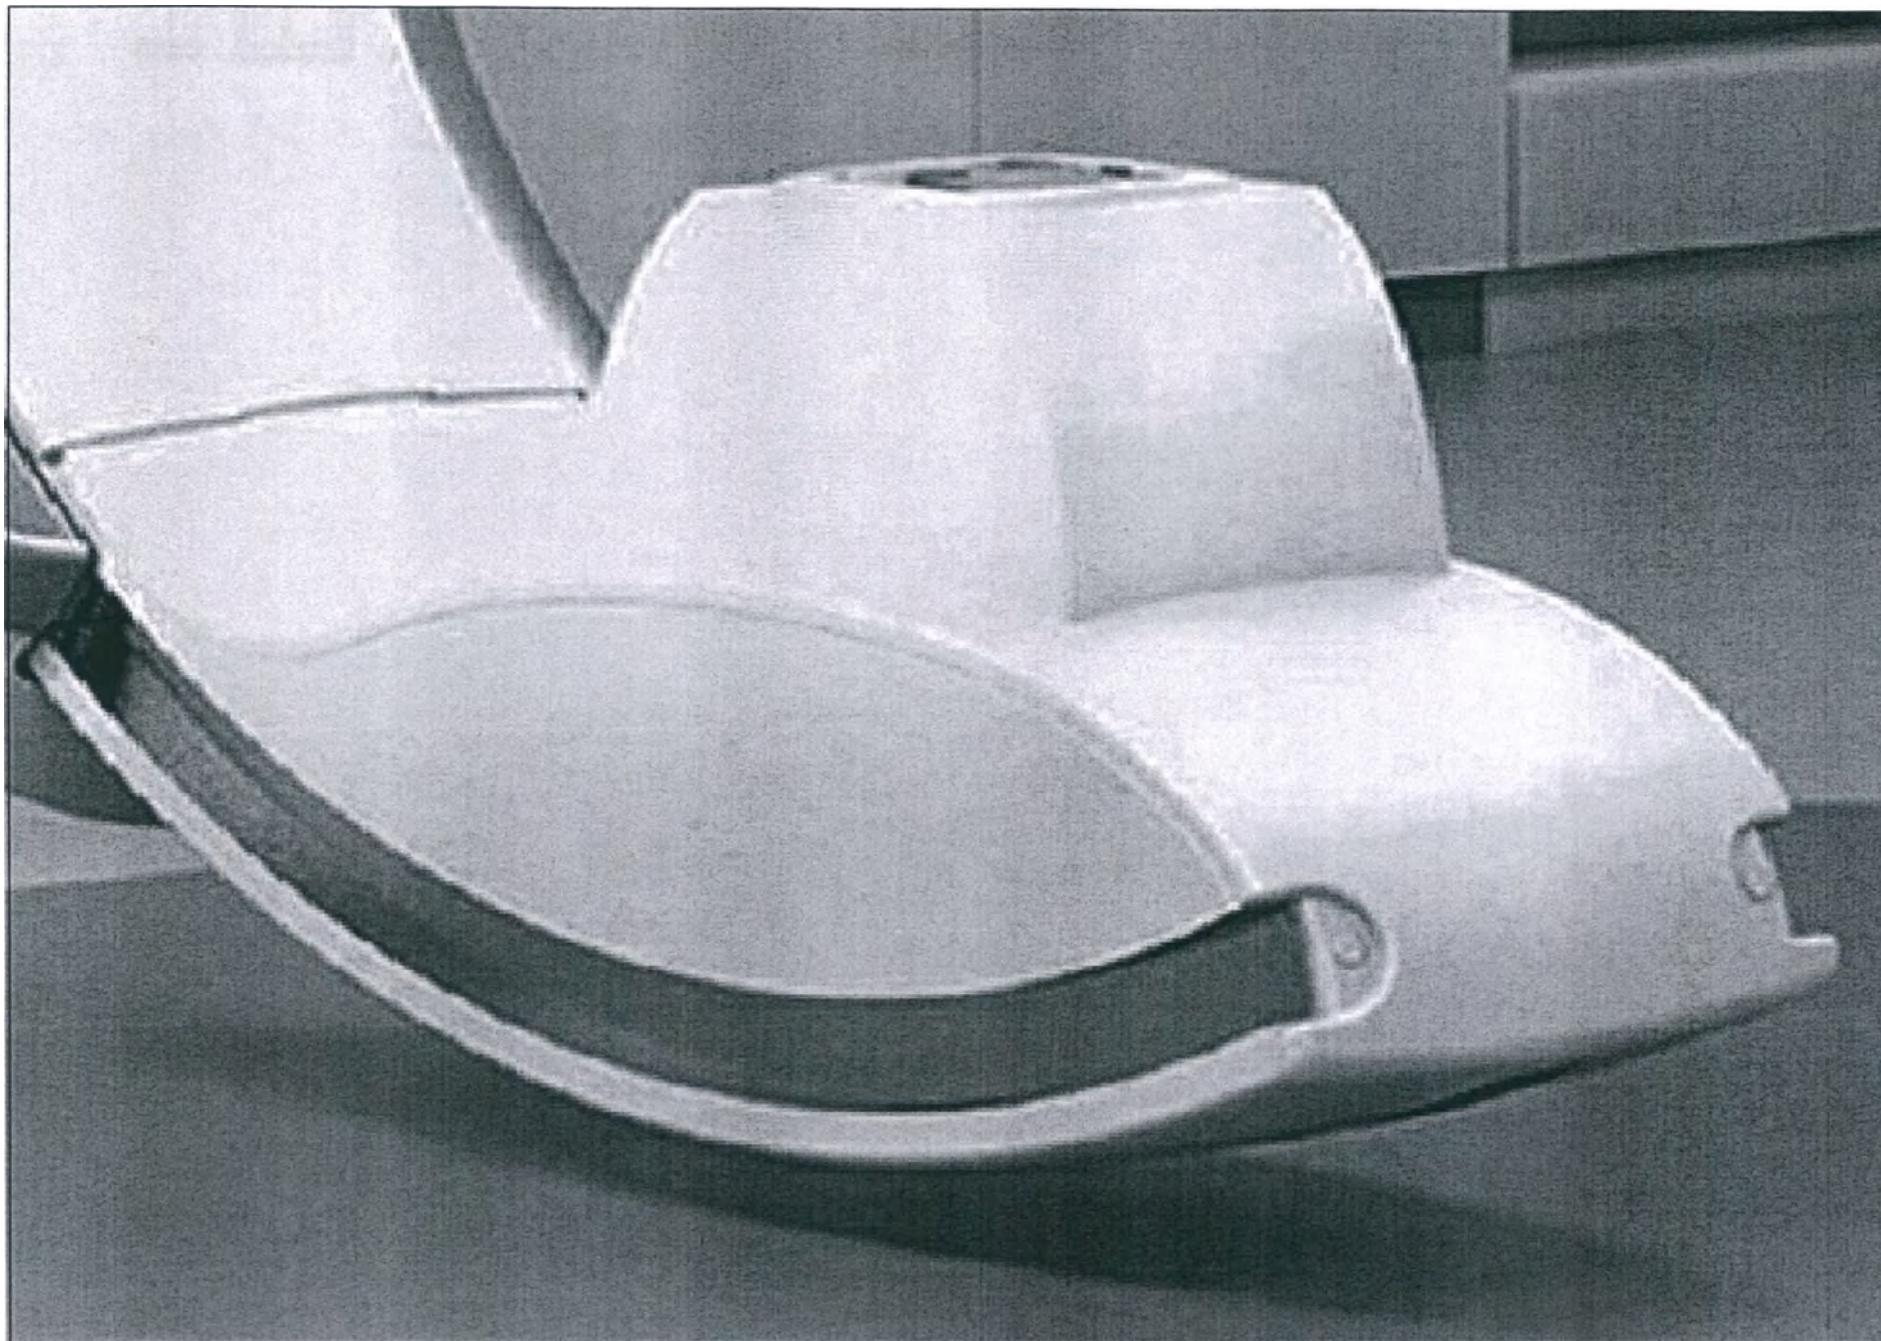


1.д. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

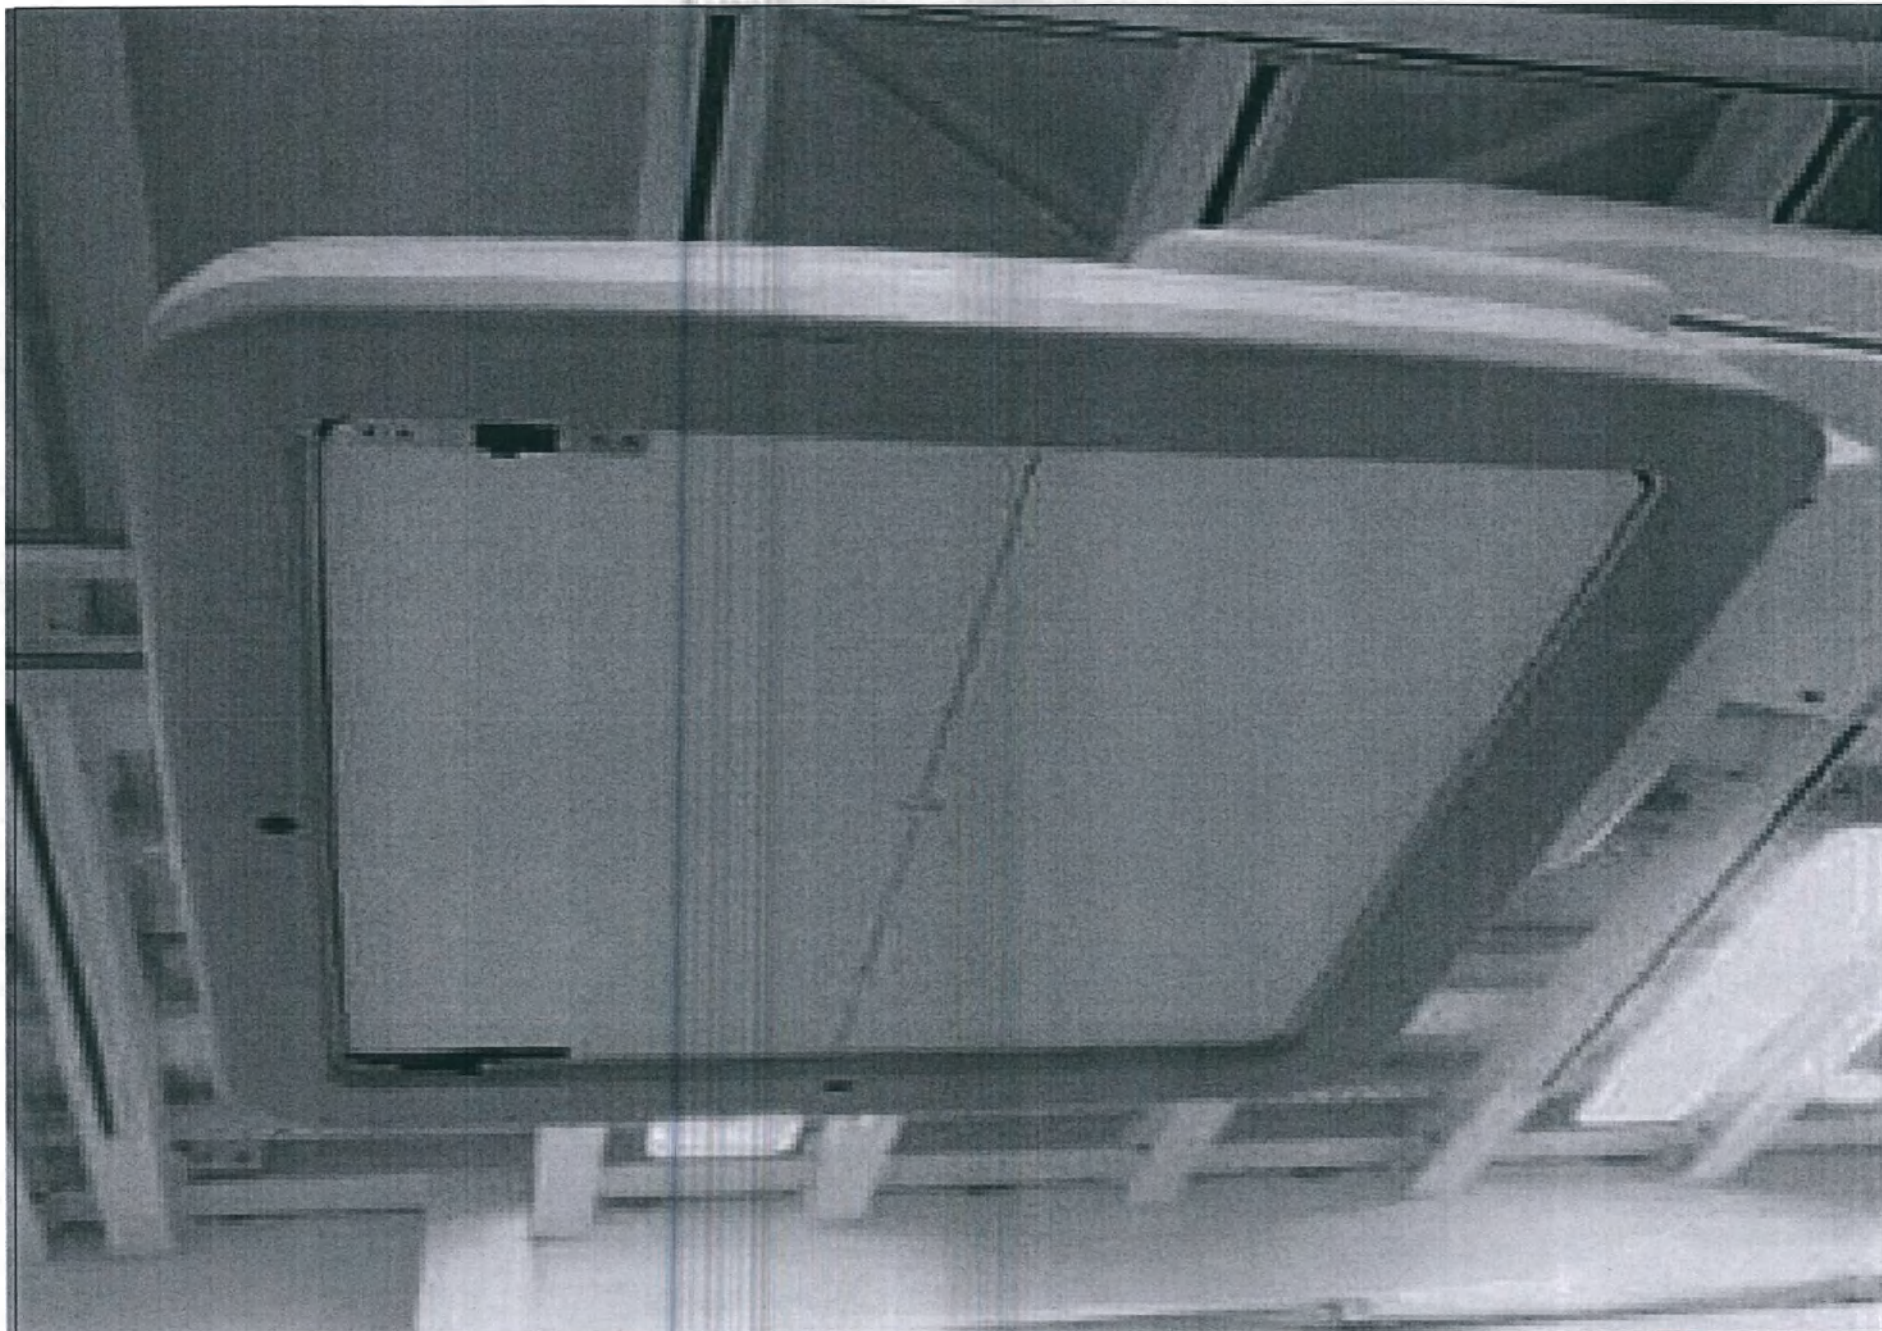

1.е. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.




2.а. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

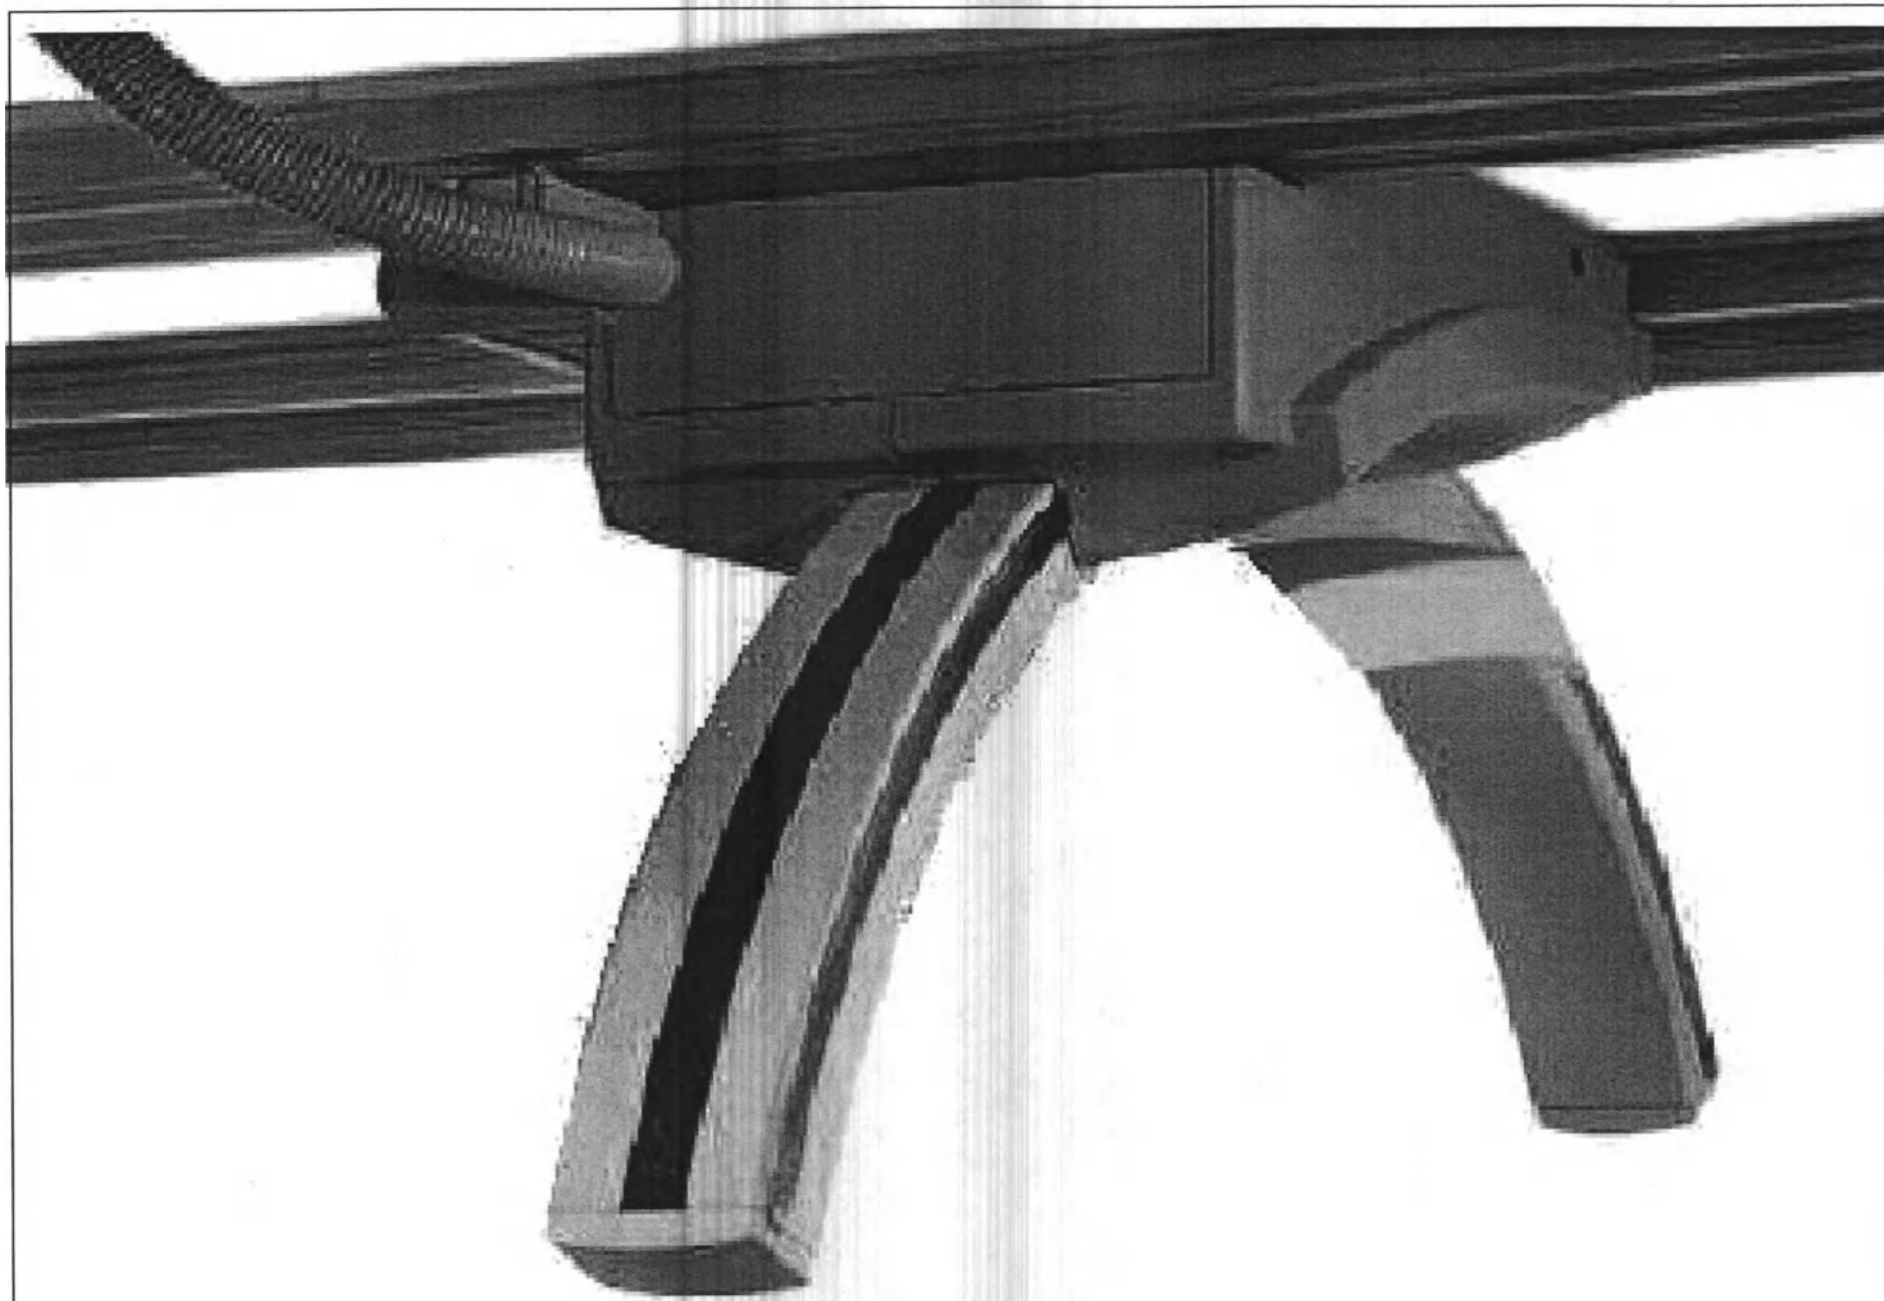


2.6. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.




2.в. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.

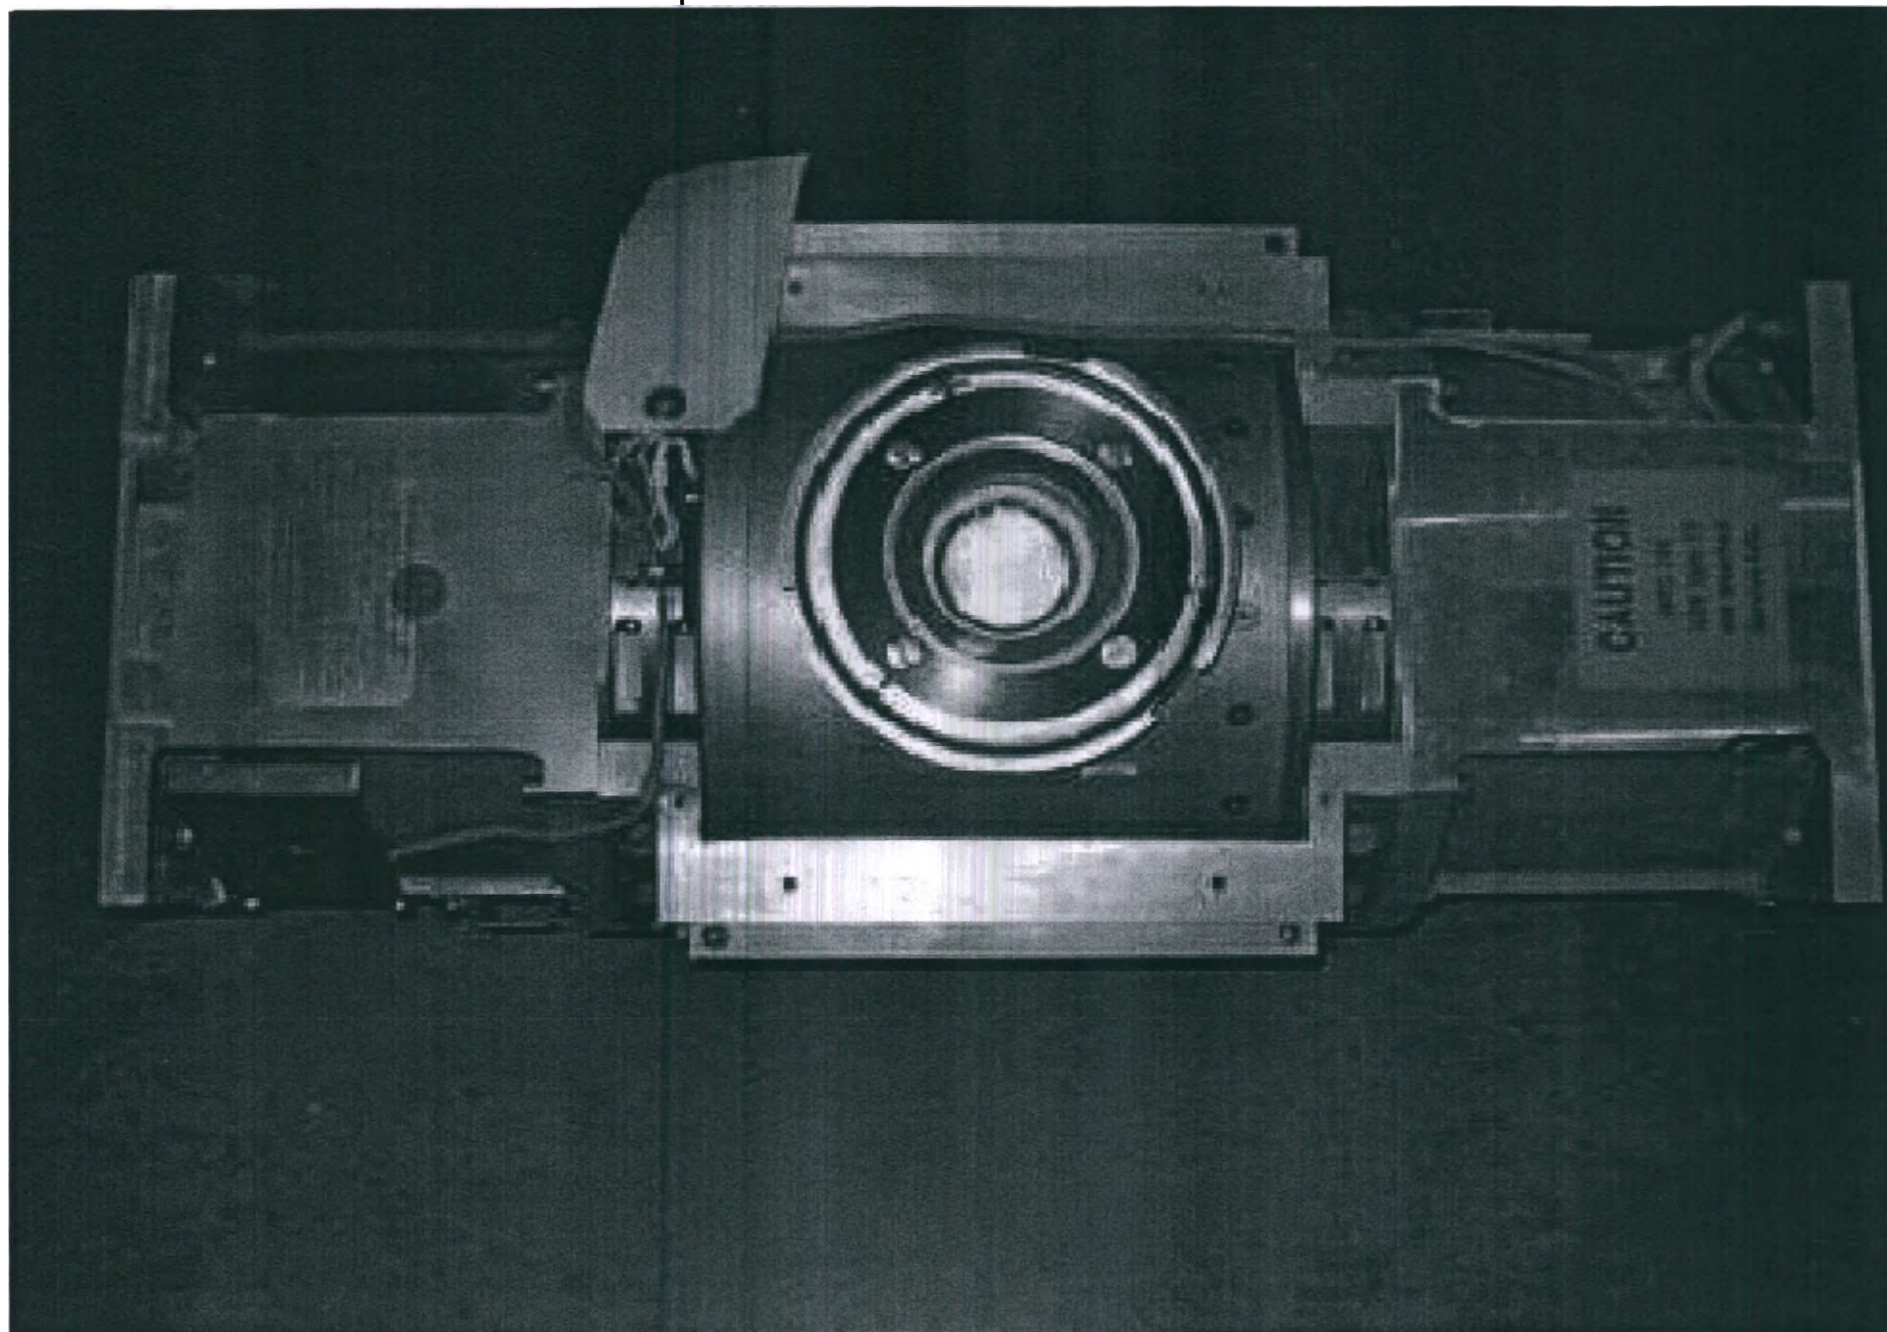


2.2. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.

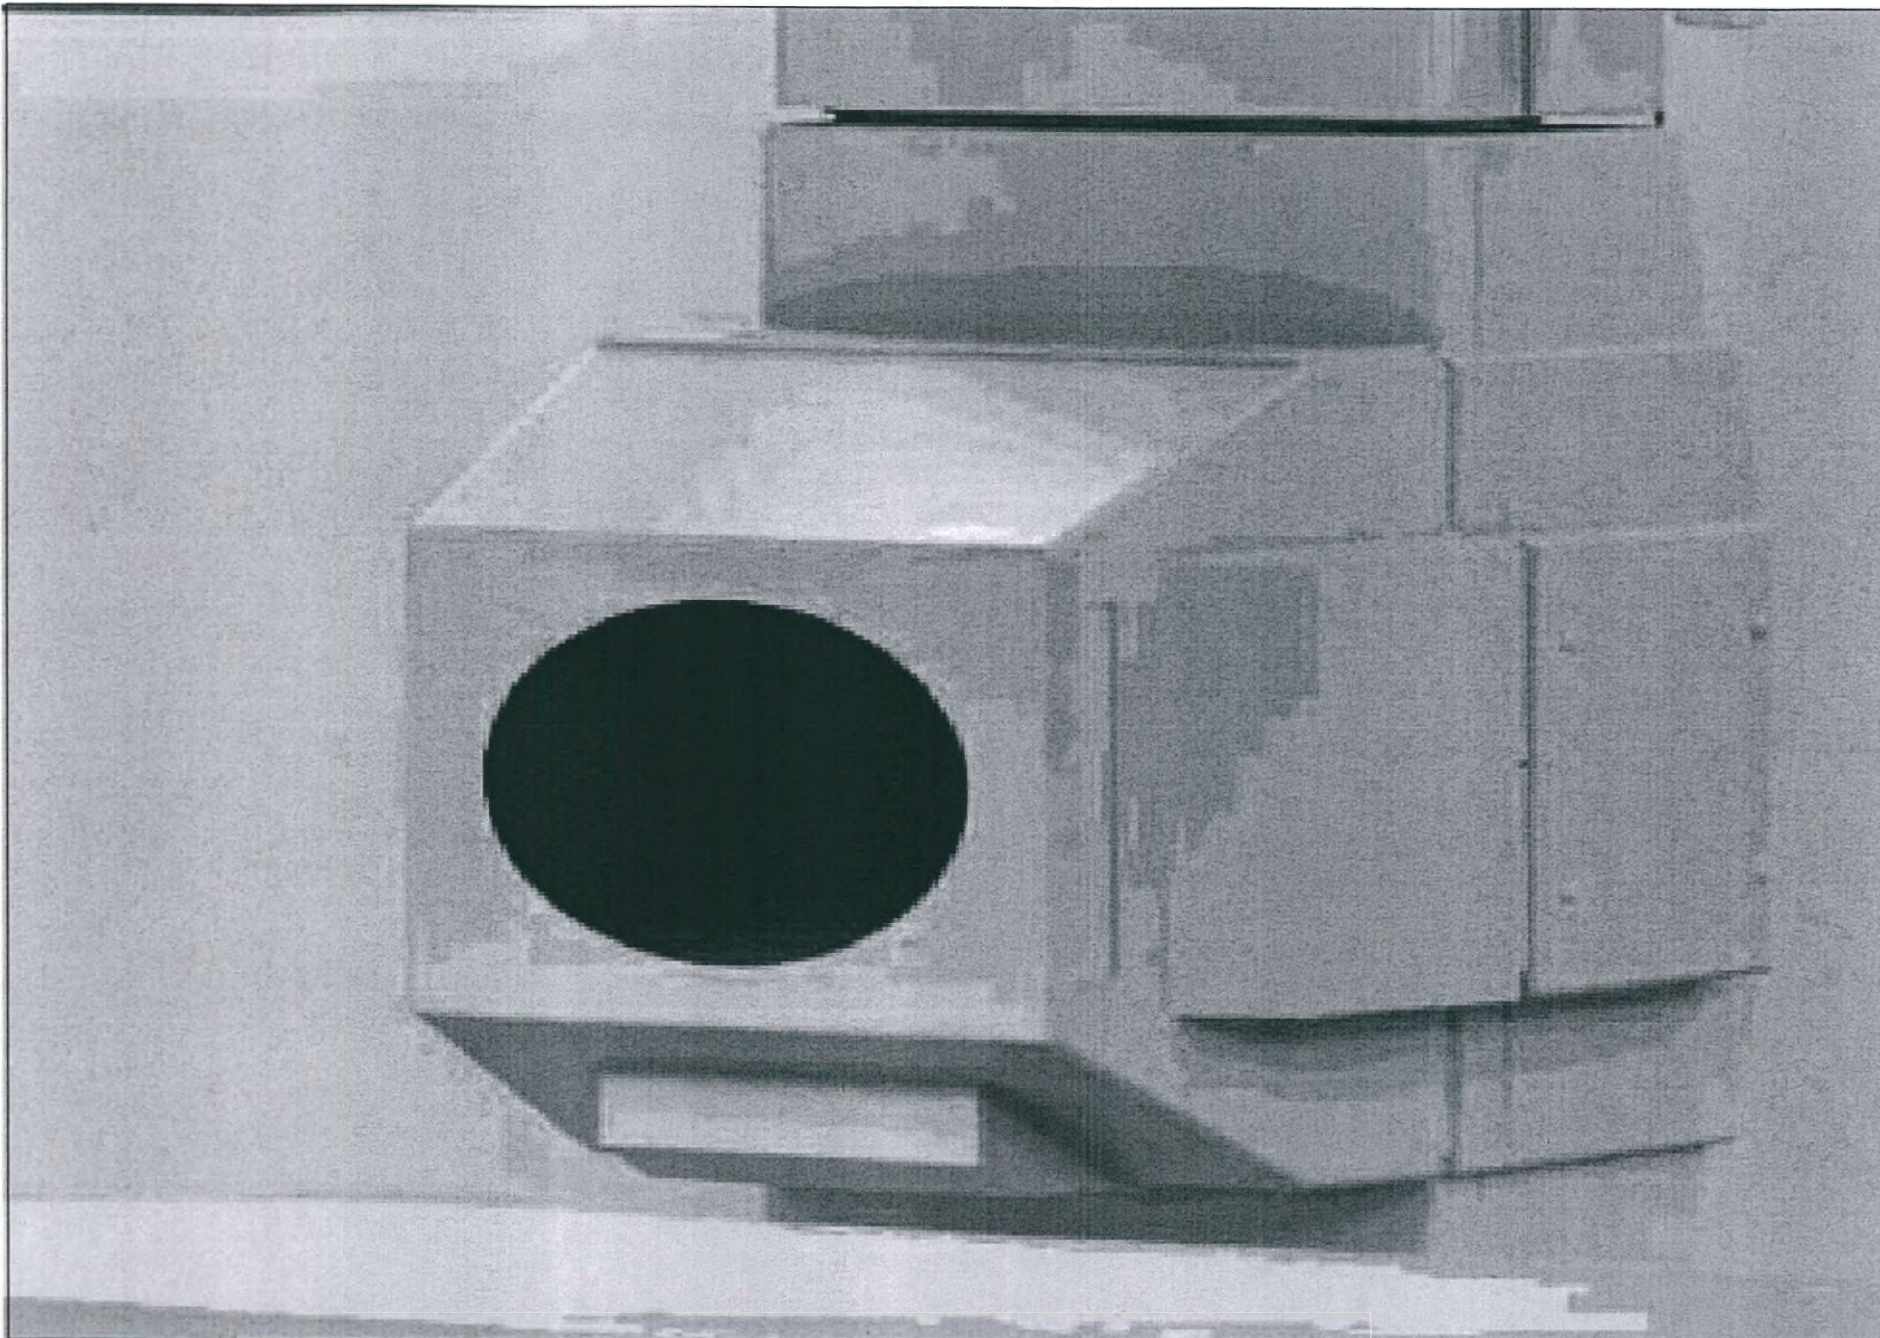


2.д. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

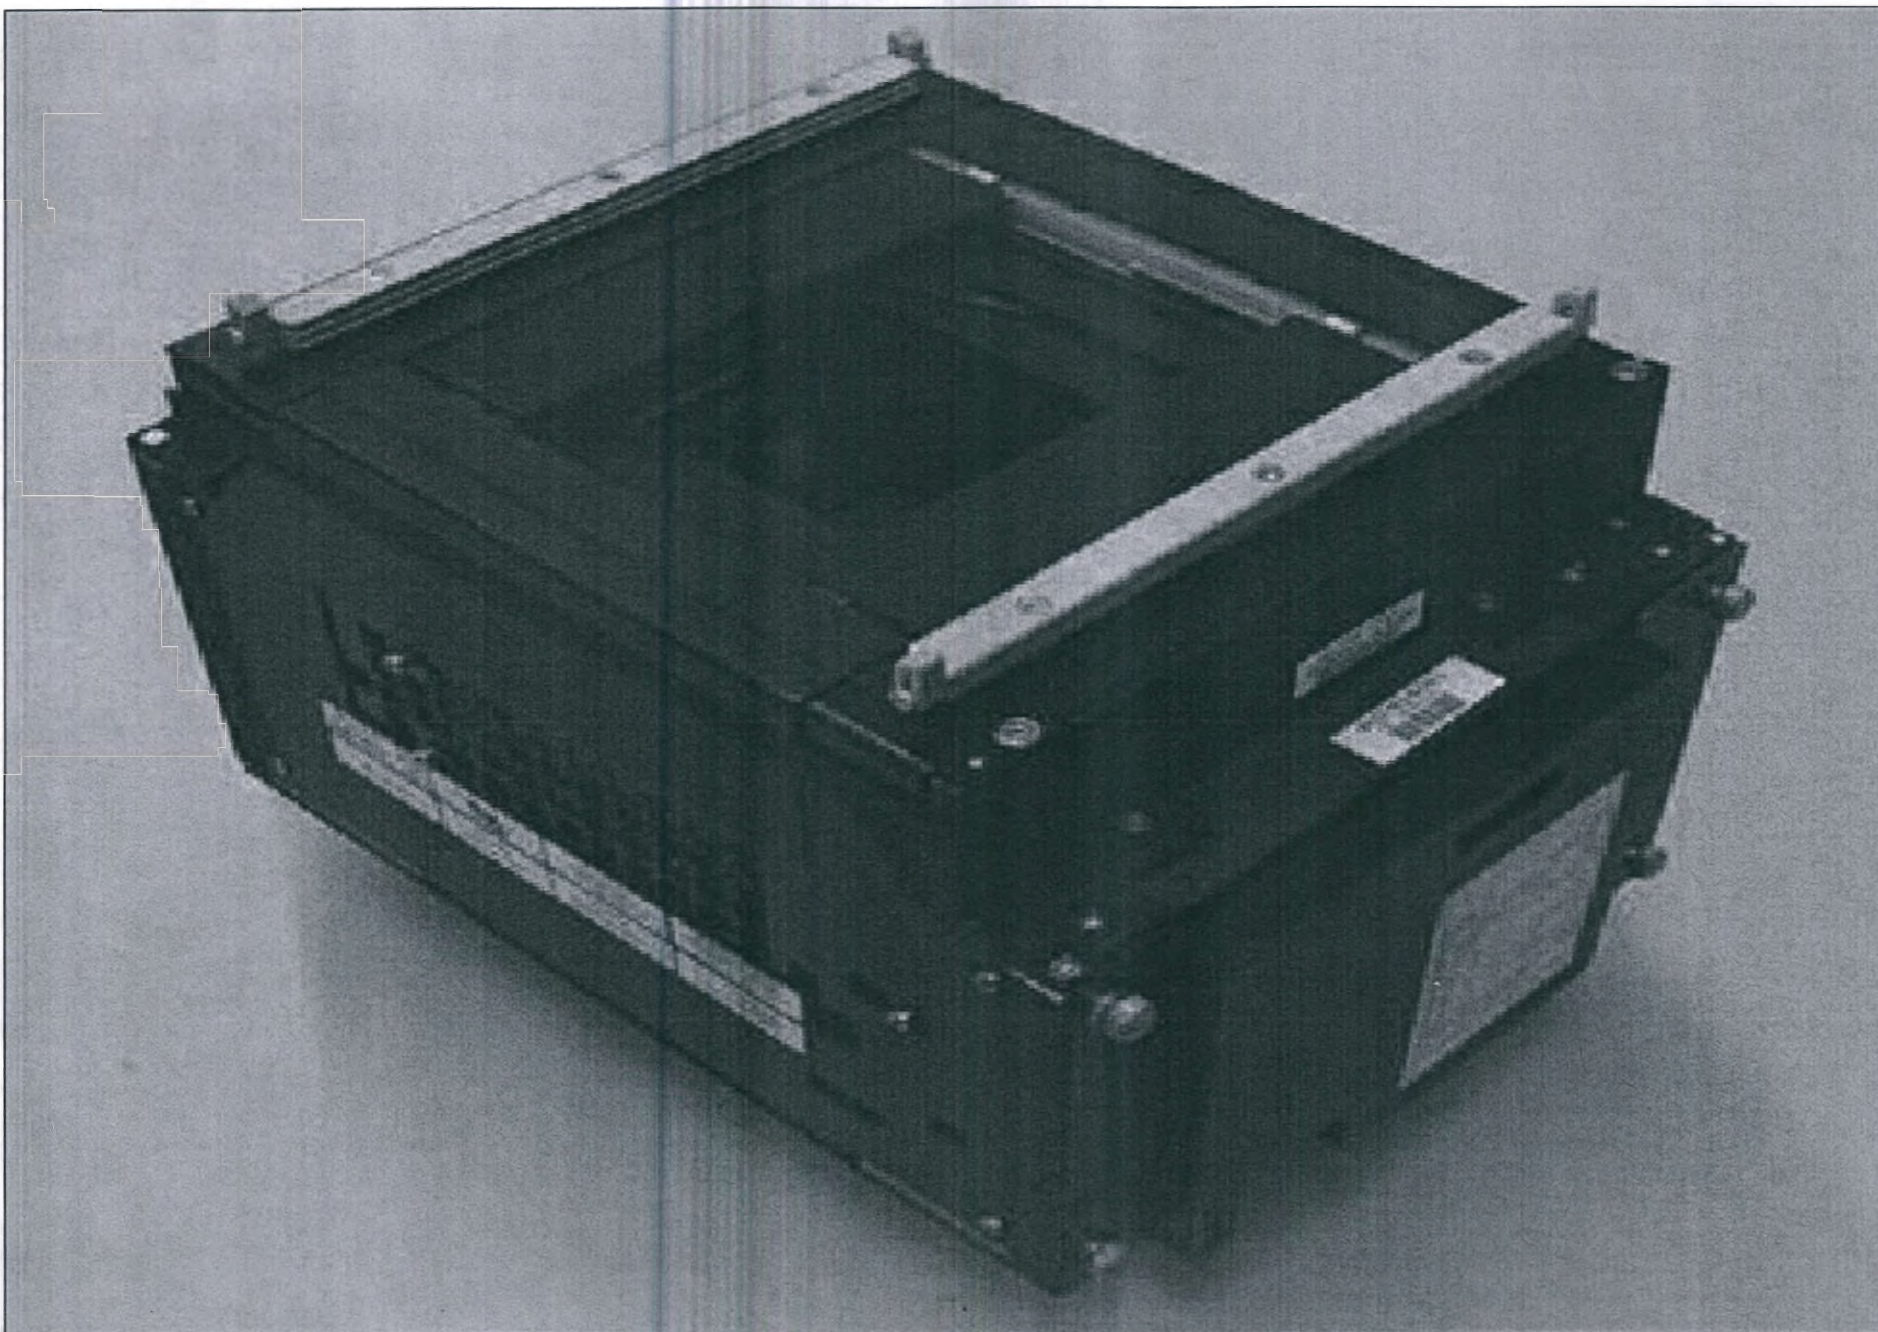


2.е. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.

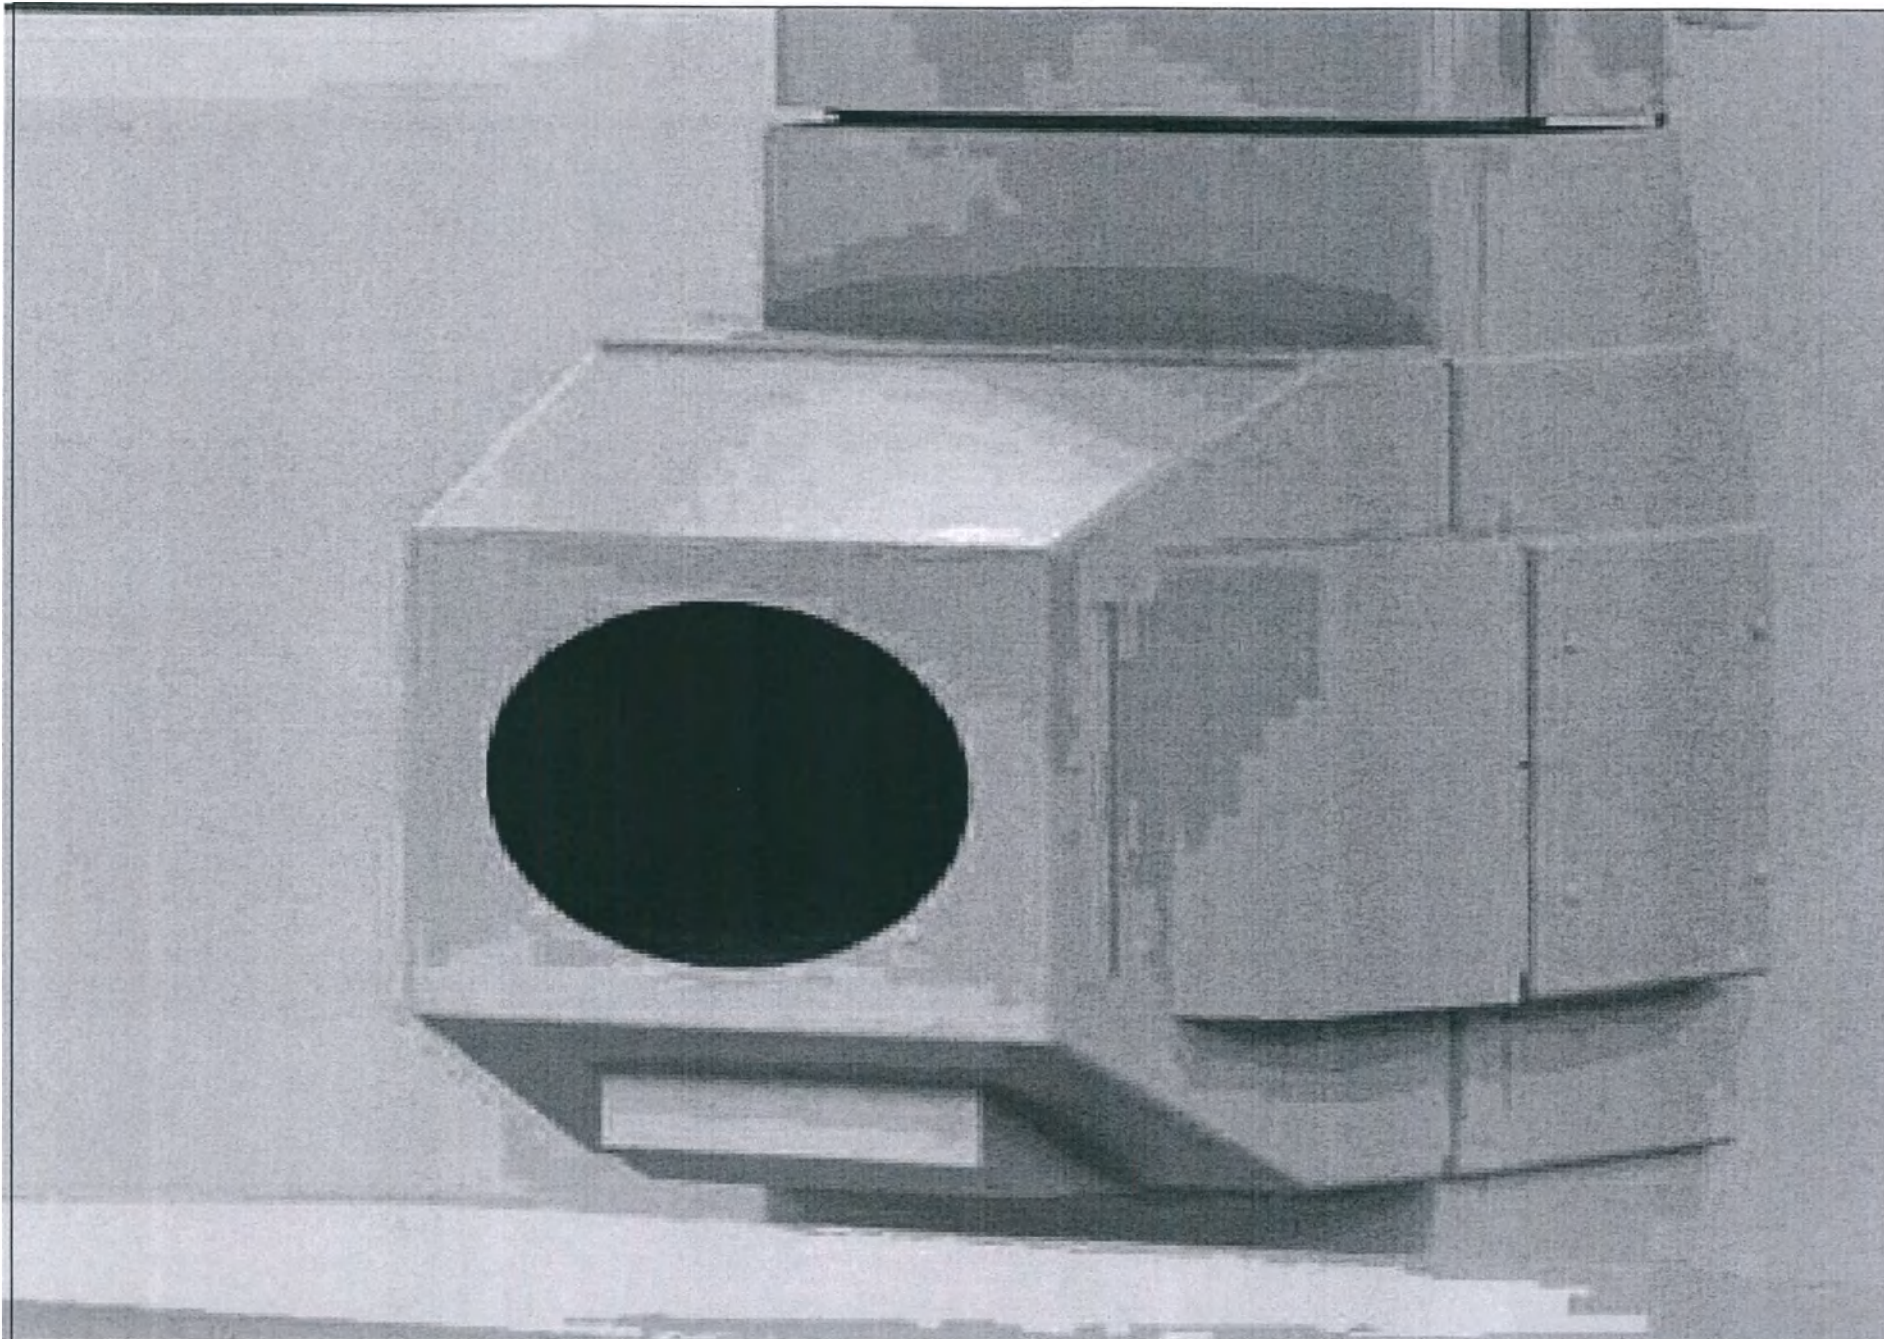


2ж. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.

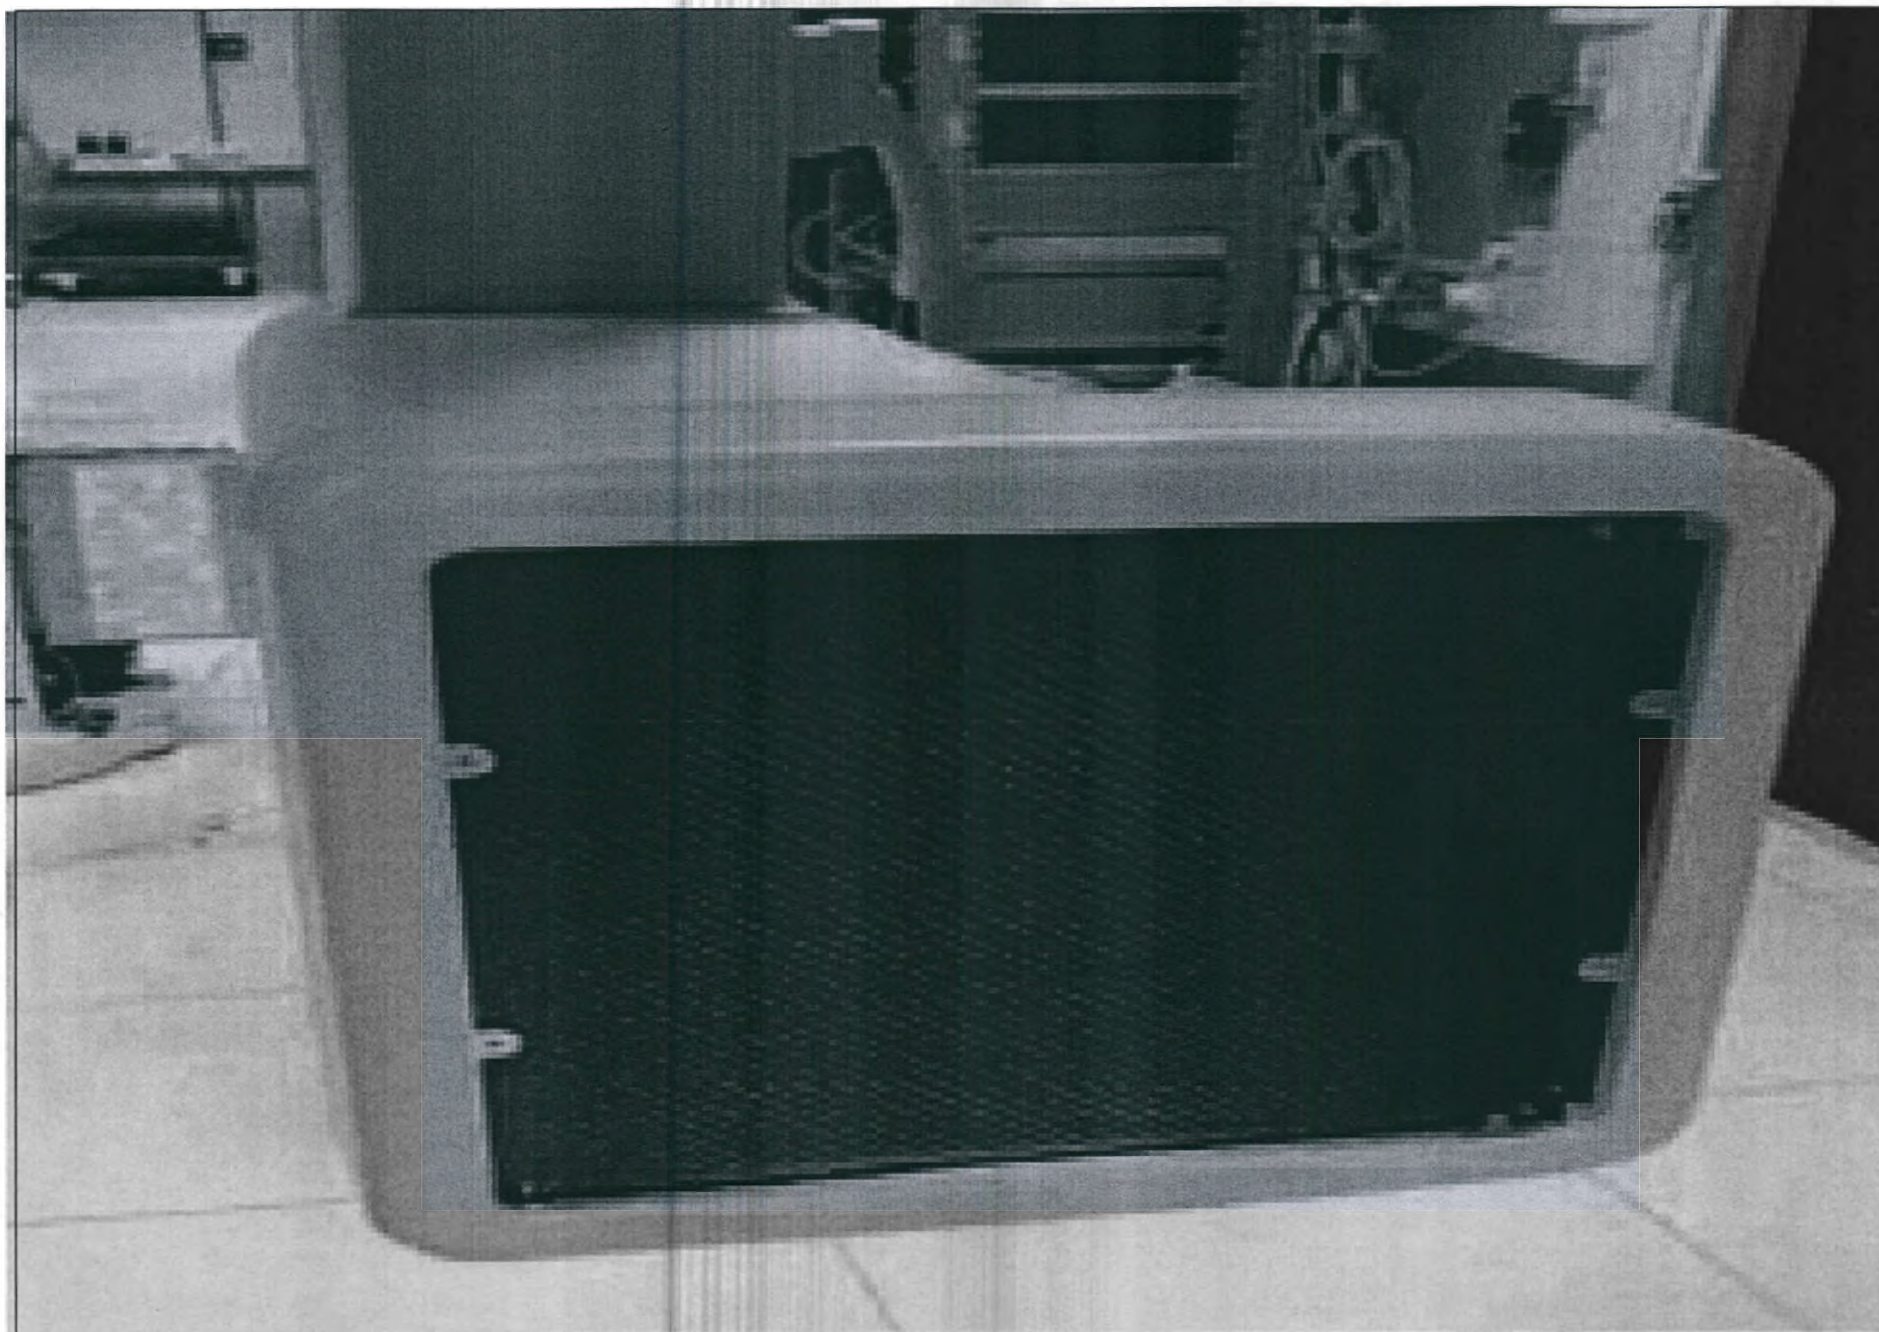


2.3. Модуль С-дуги потолочный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12

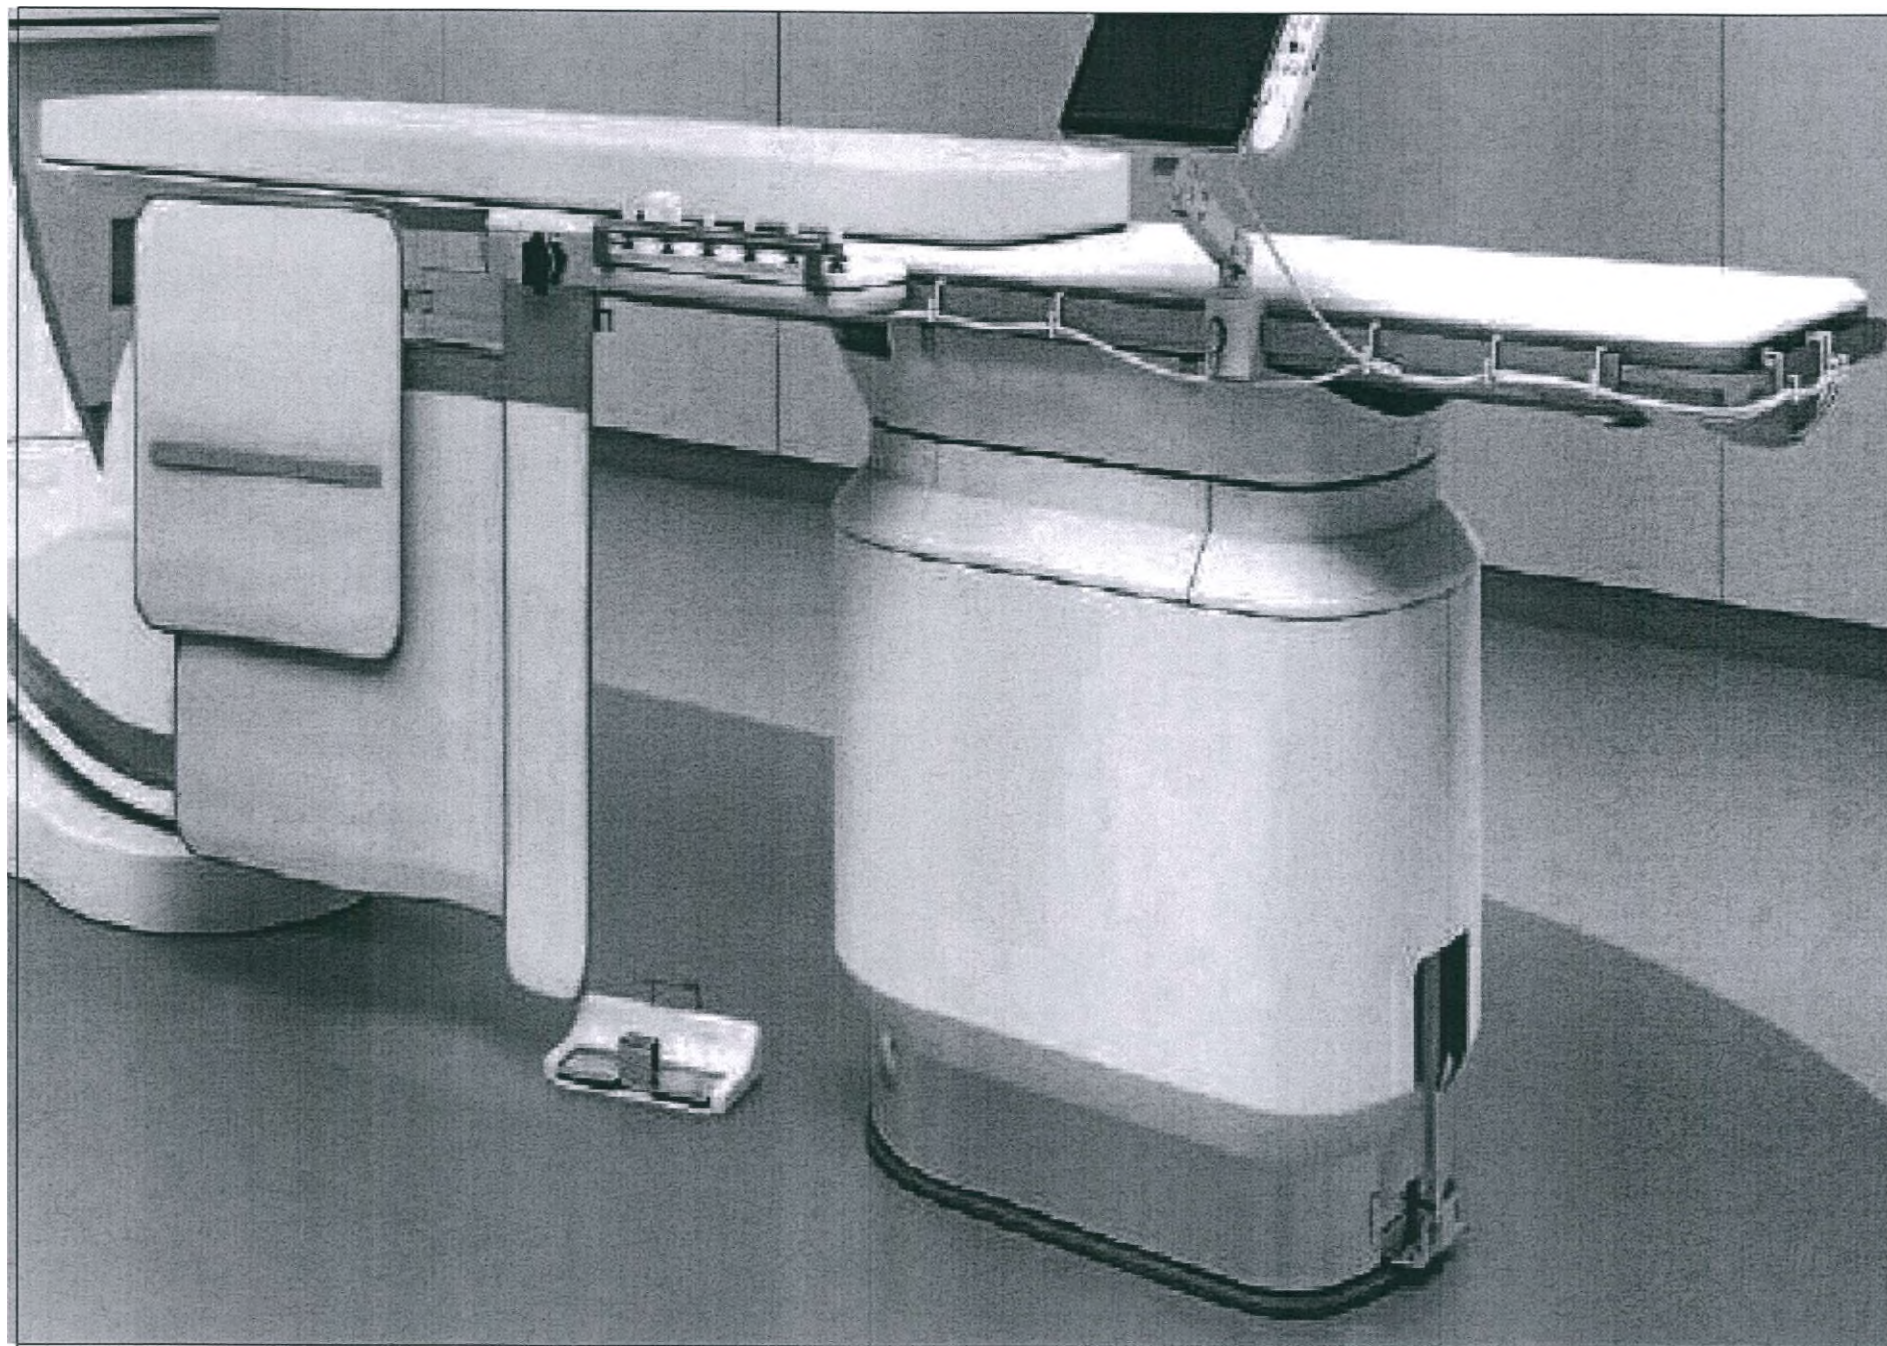


3.а. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

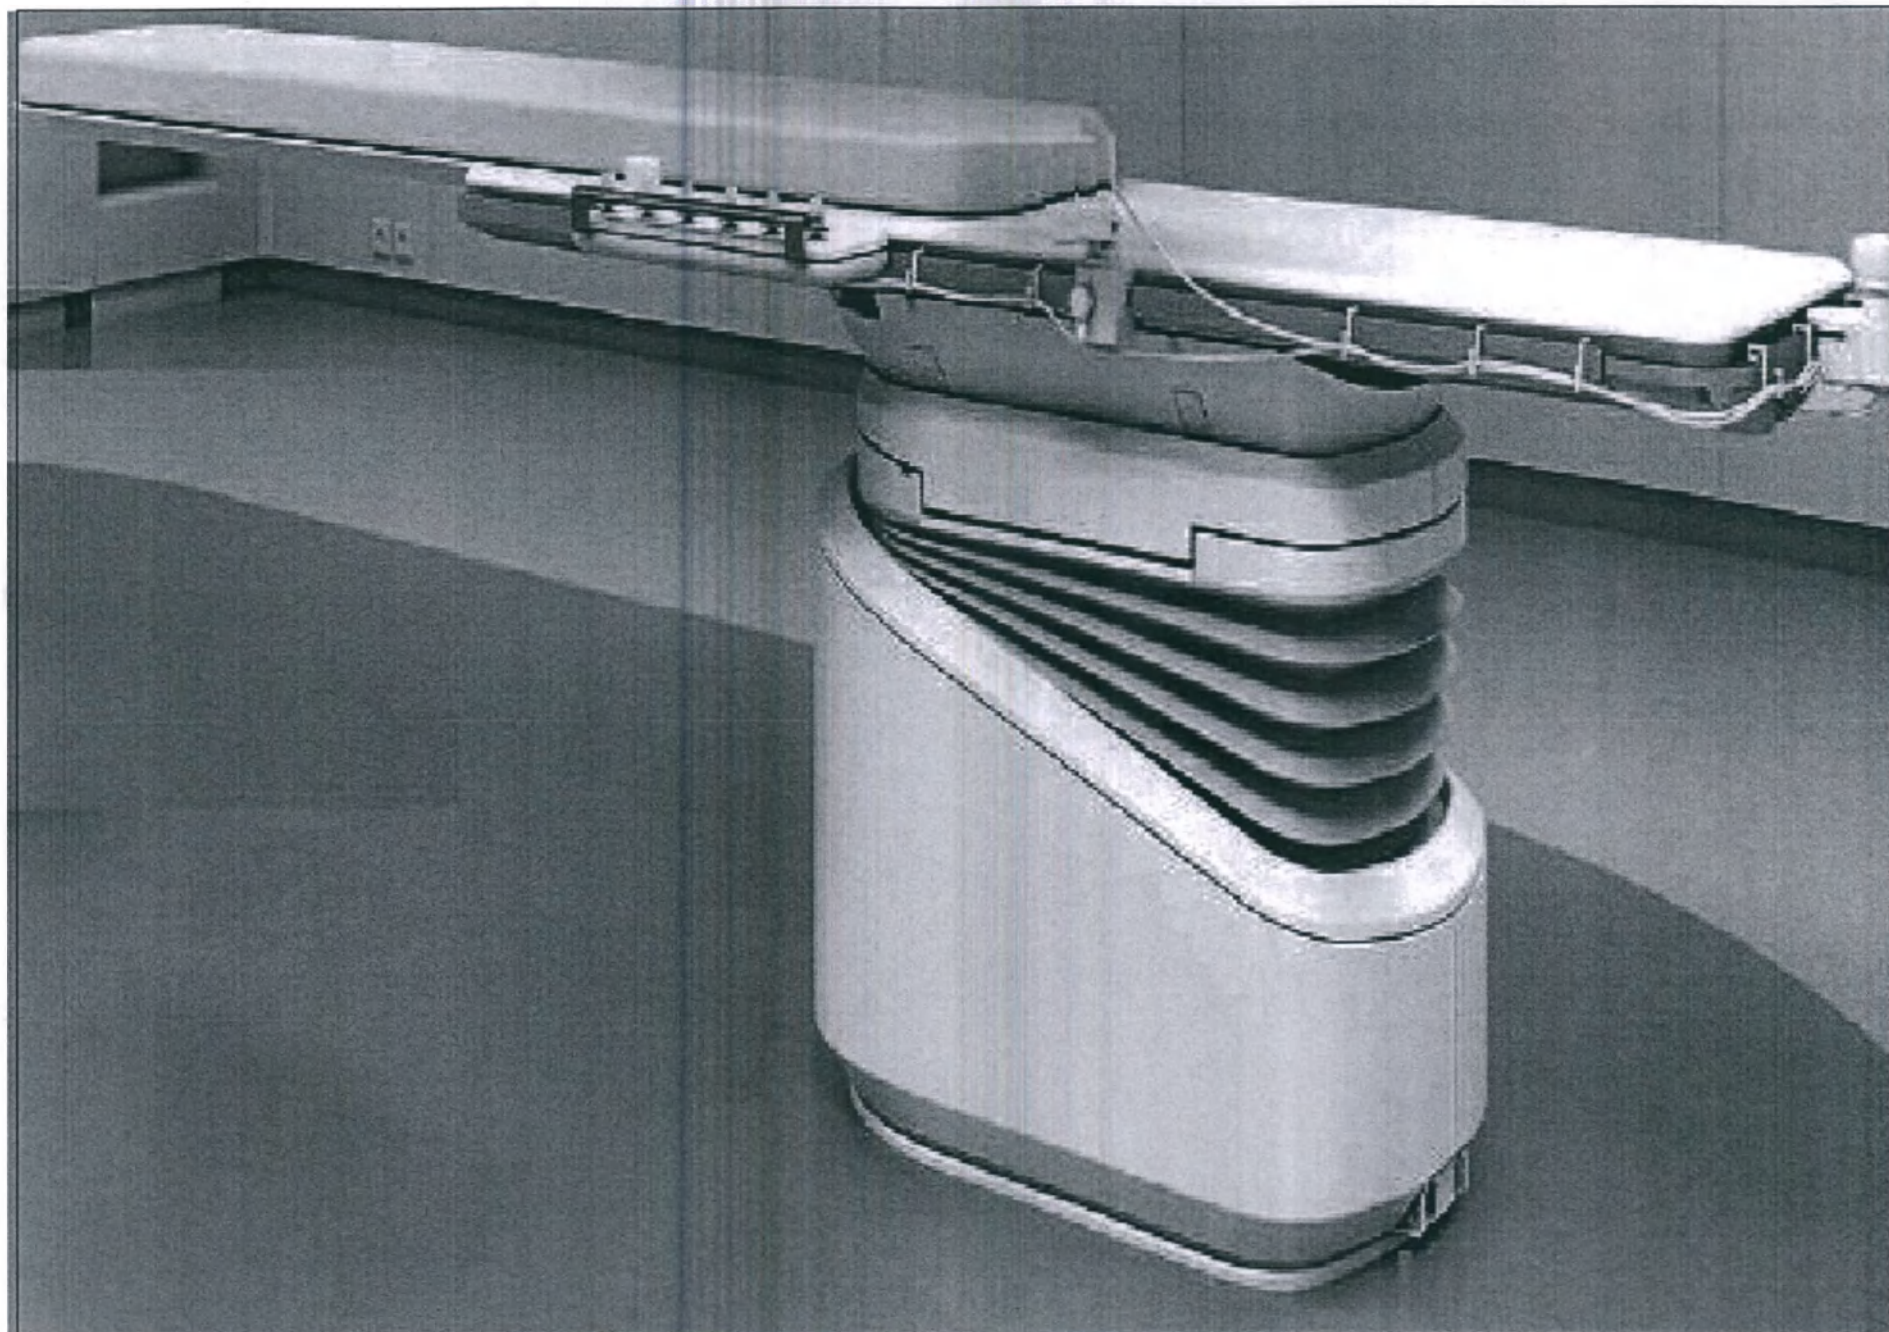


3.б. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

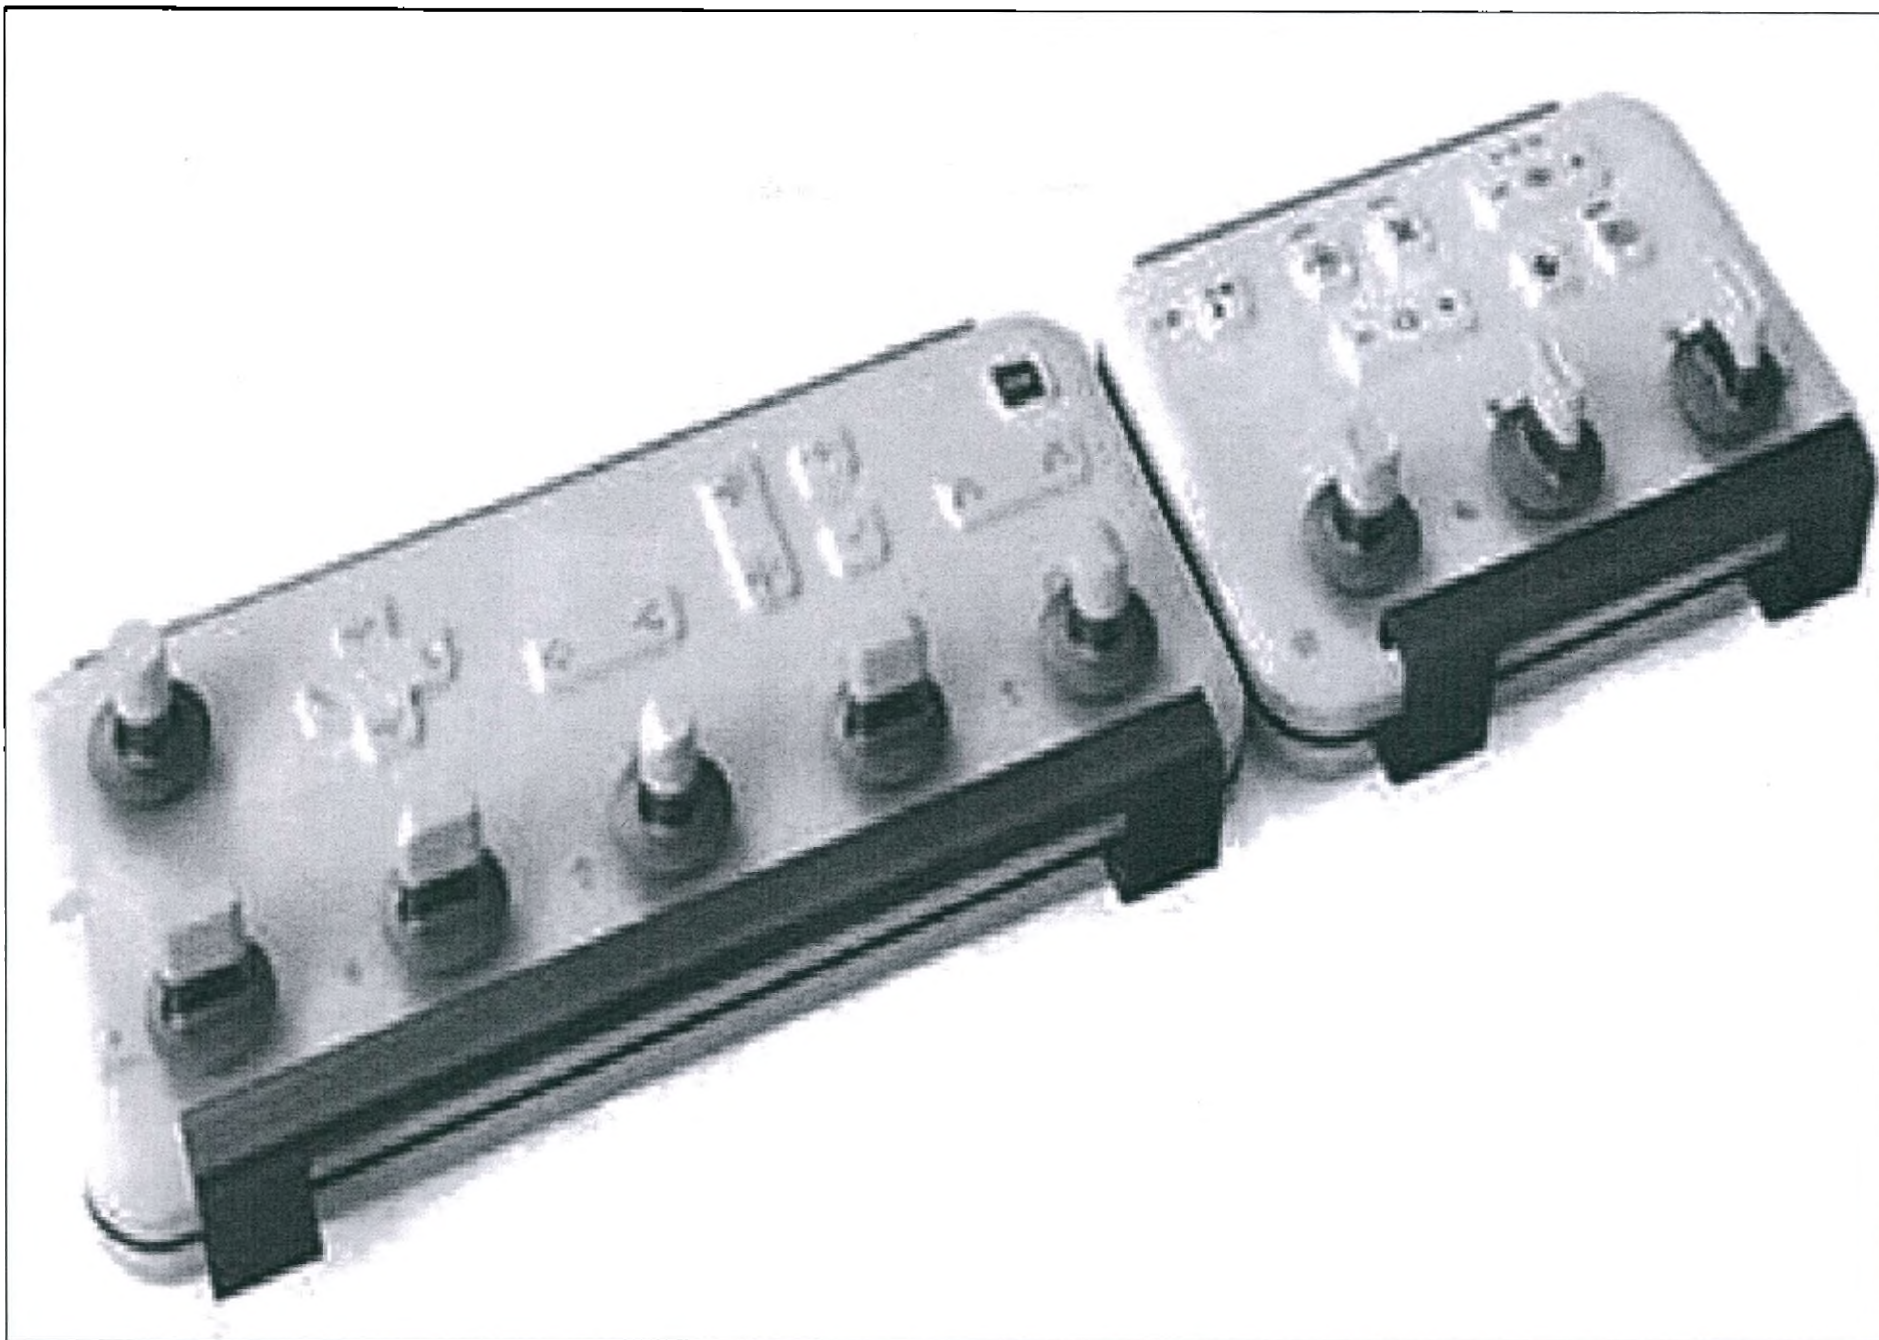

4. Модуль управления, не более 4 шт.

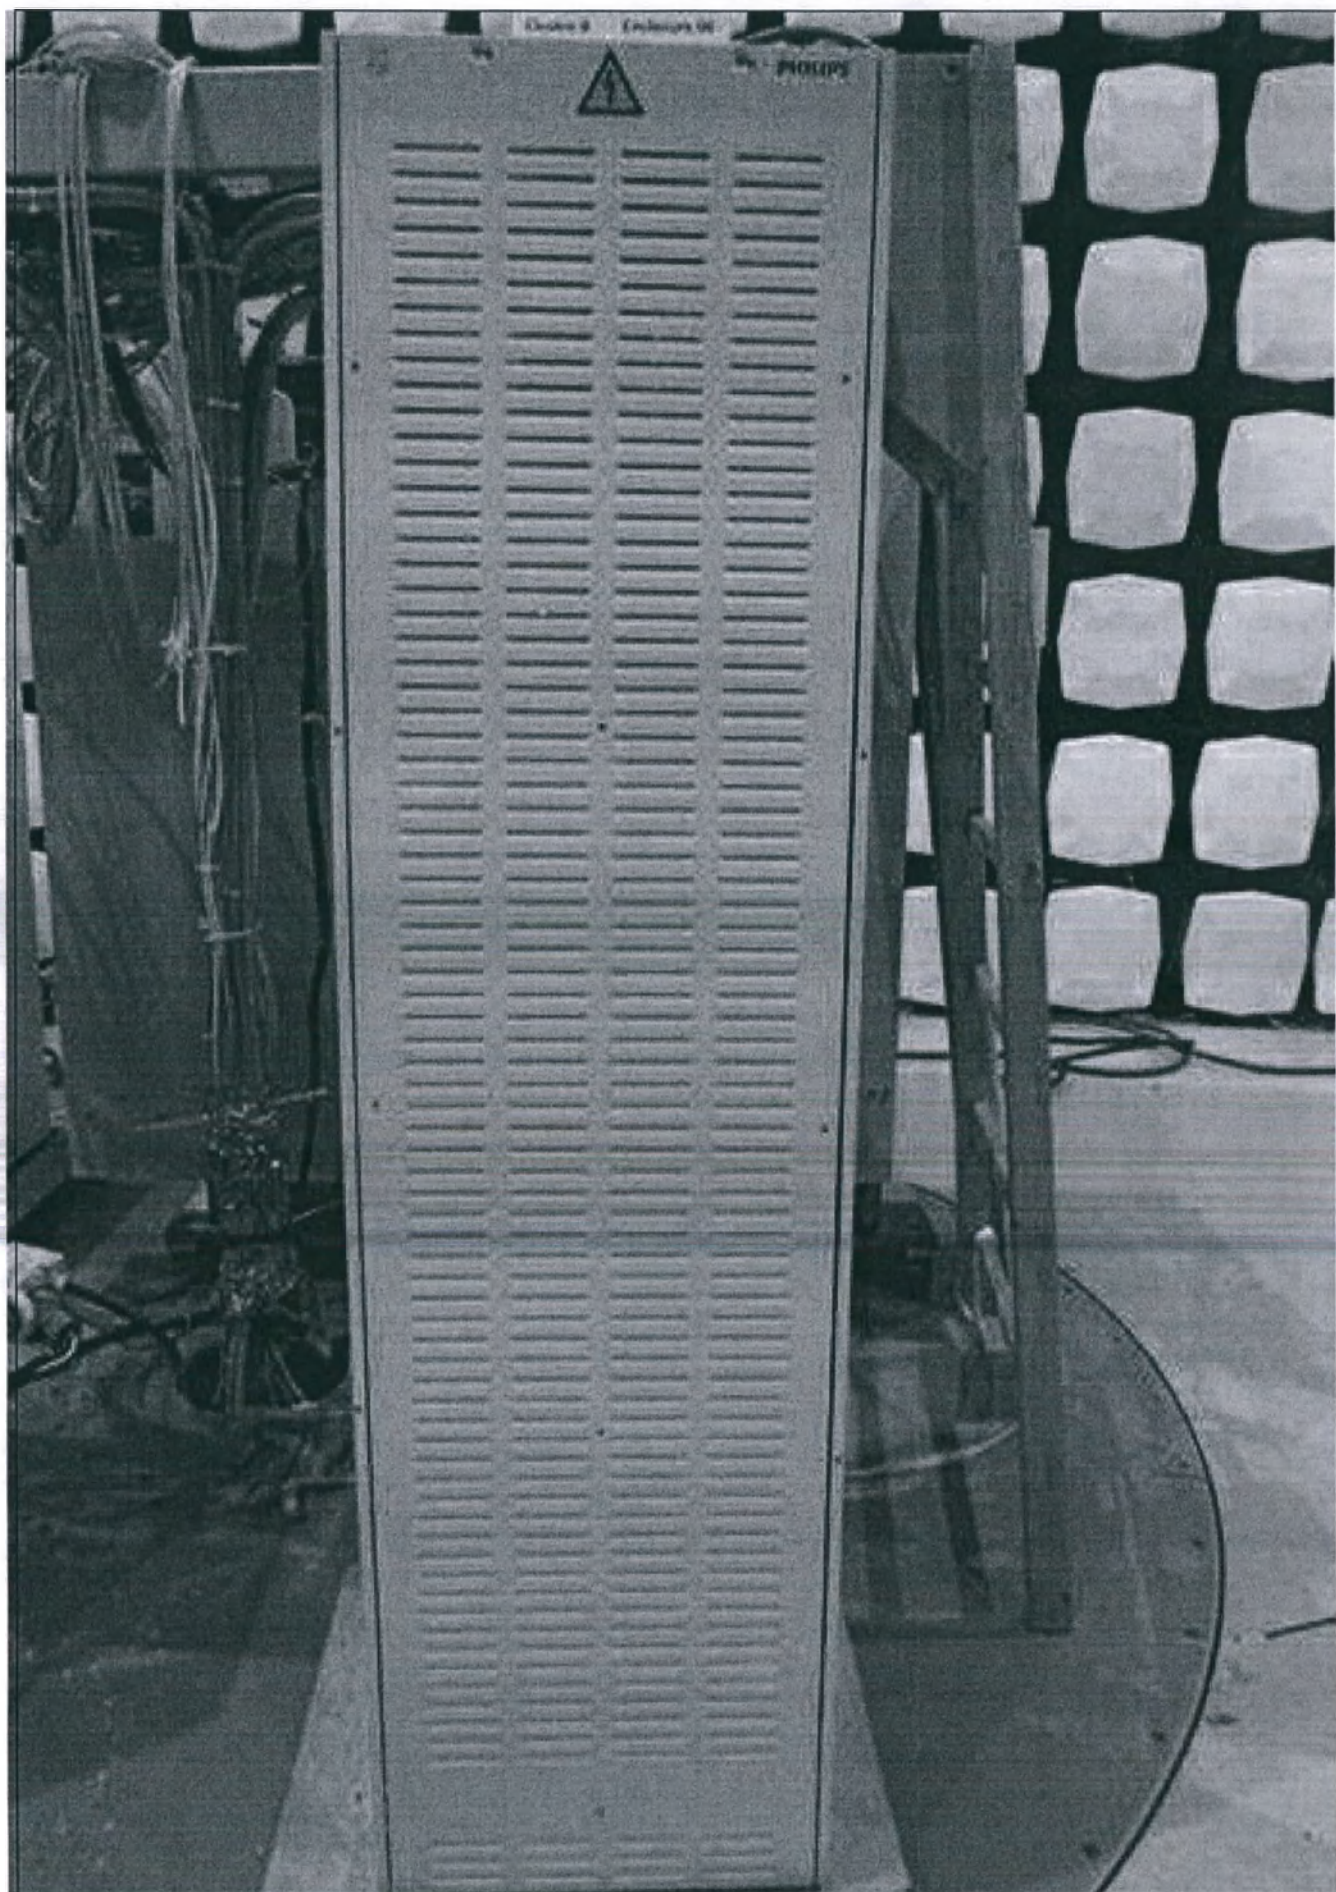



5.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

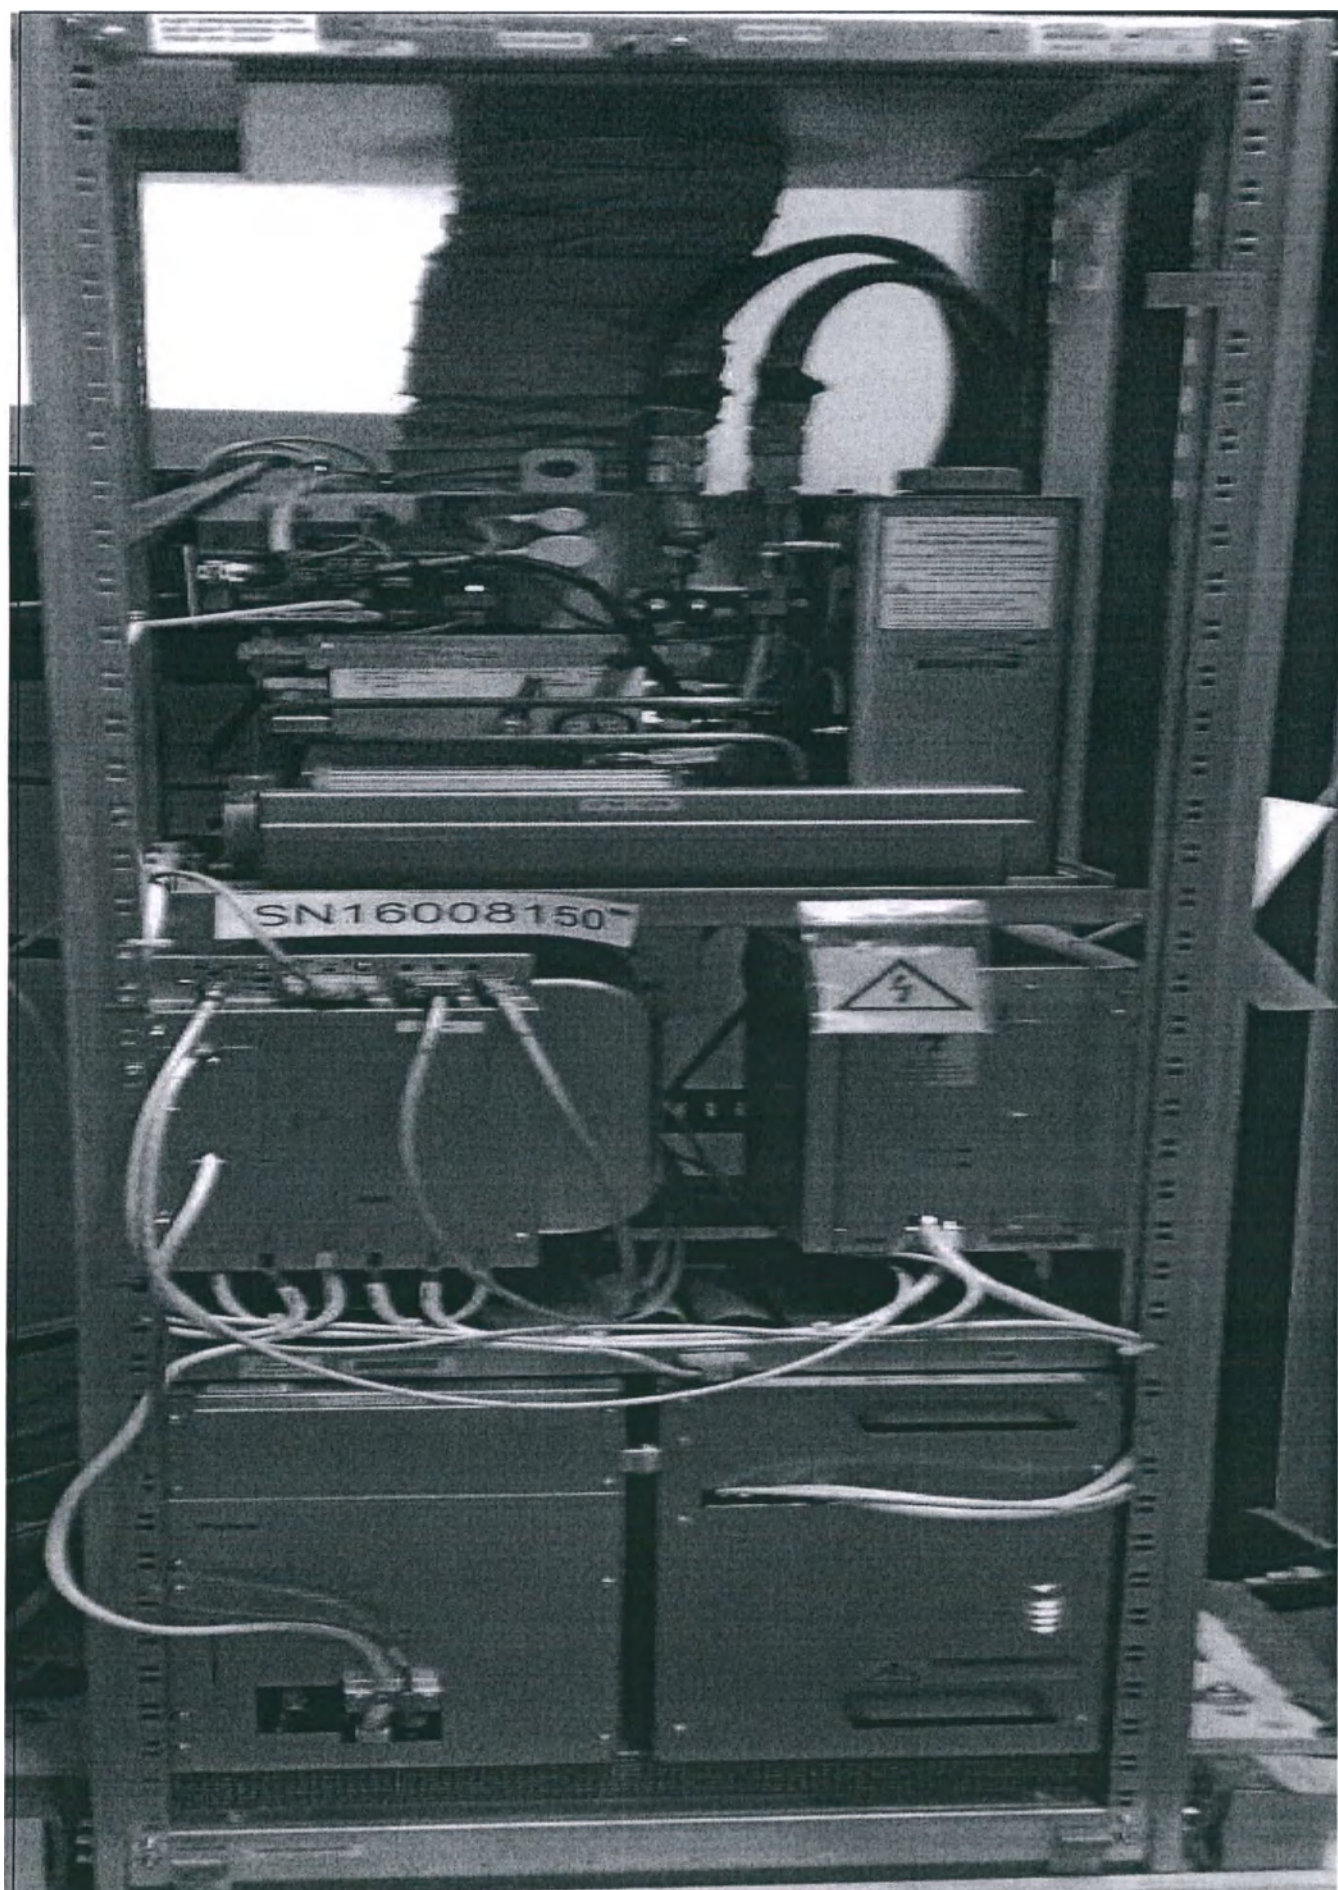


5.6. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

б.а. Шкаф управления.

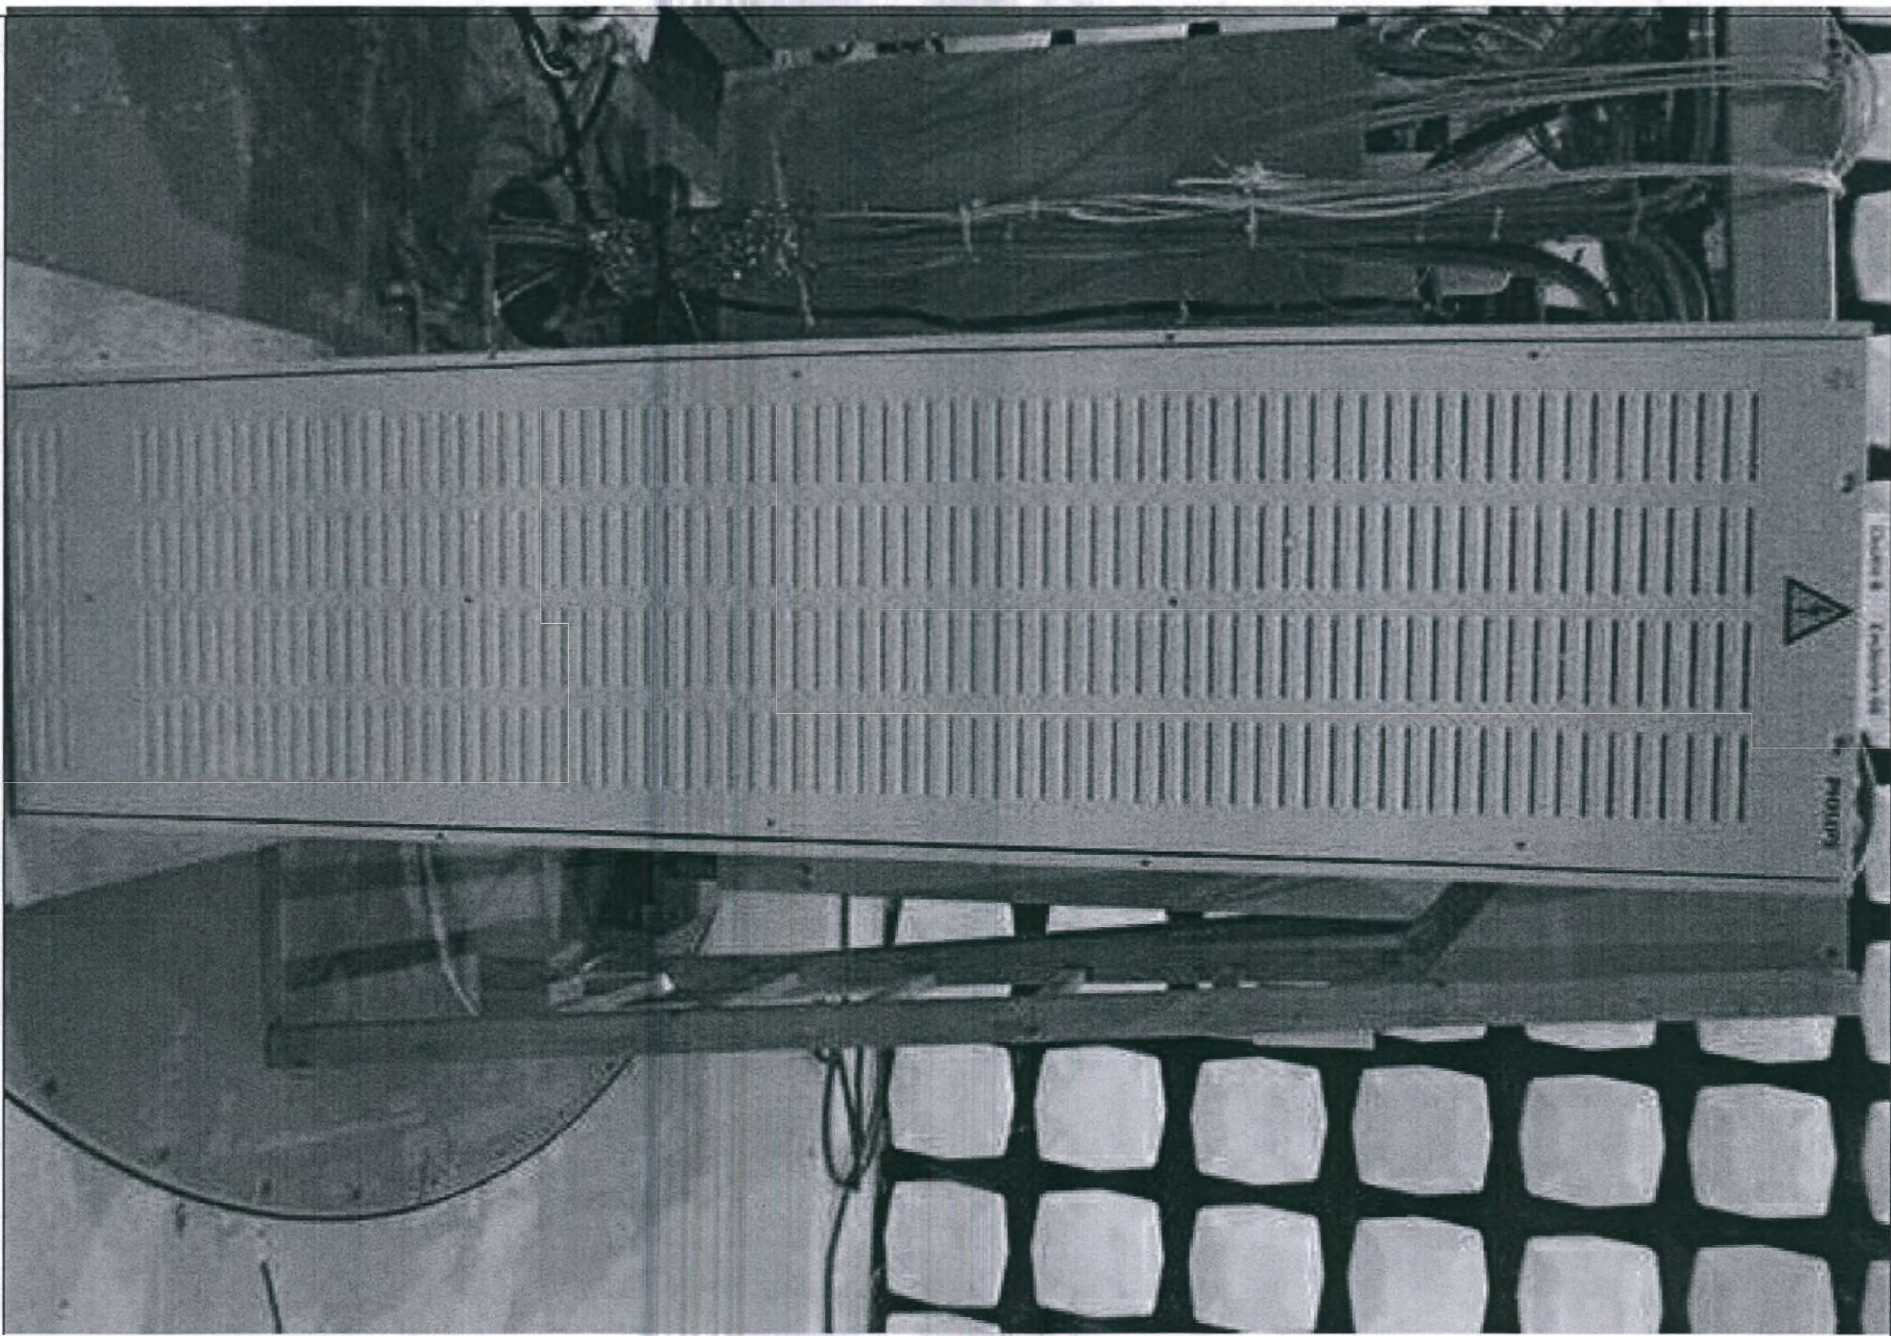


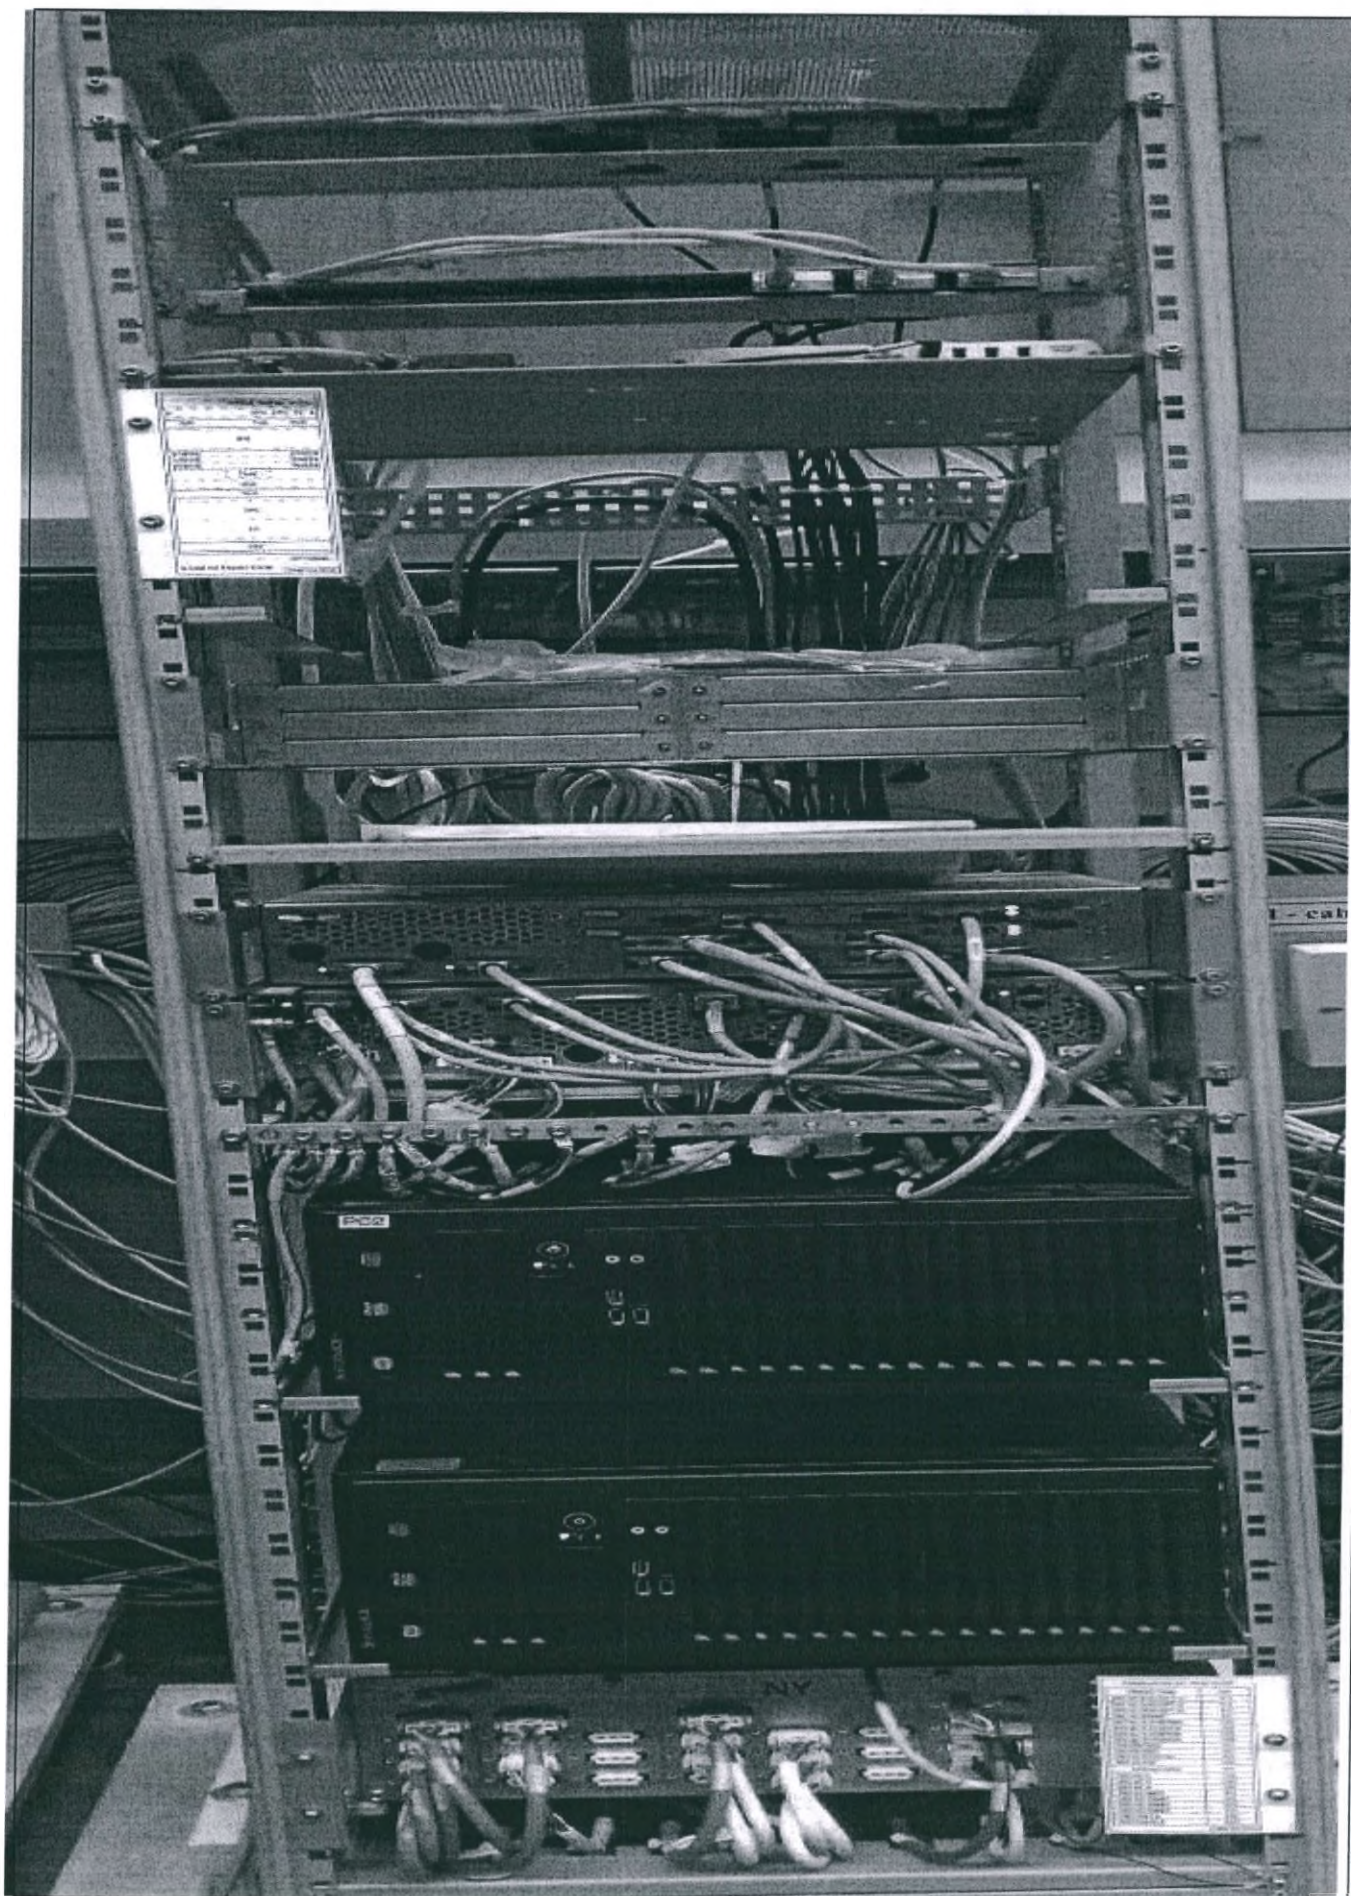


6.6. Шкаф управления.

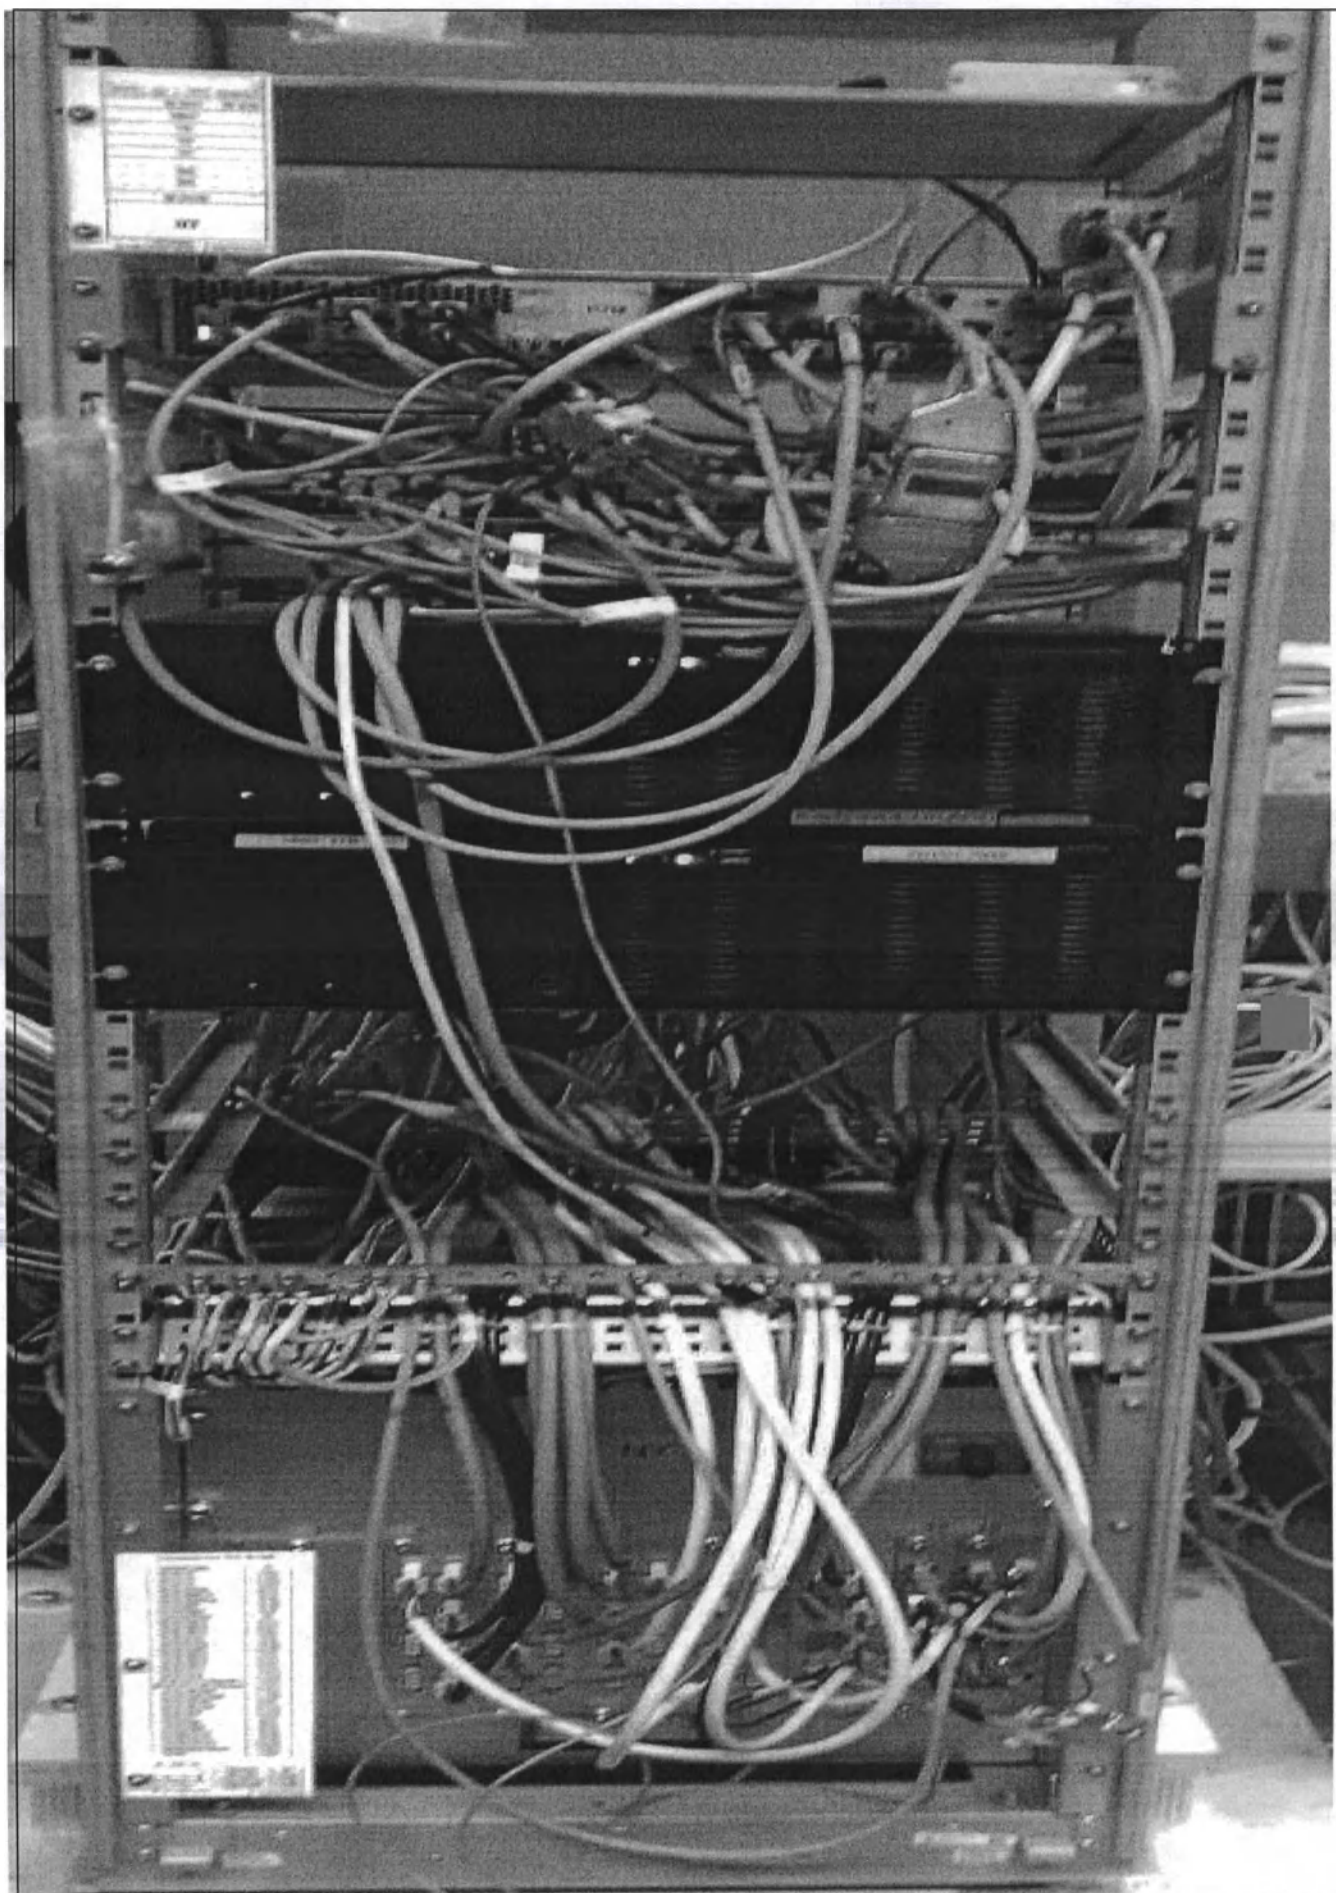


7.а. Распределительный щит.

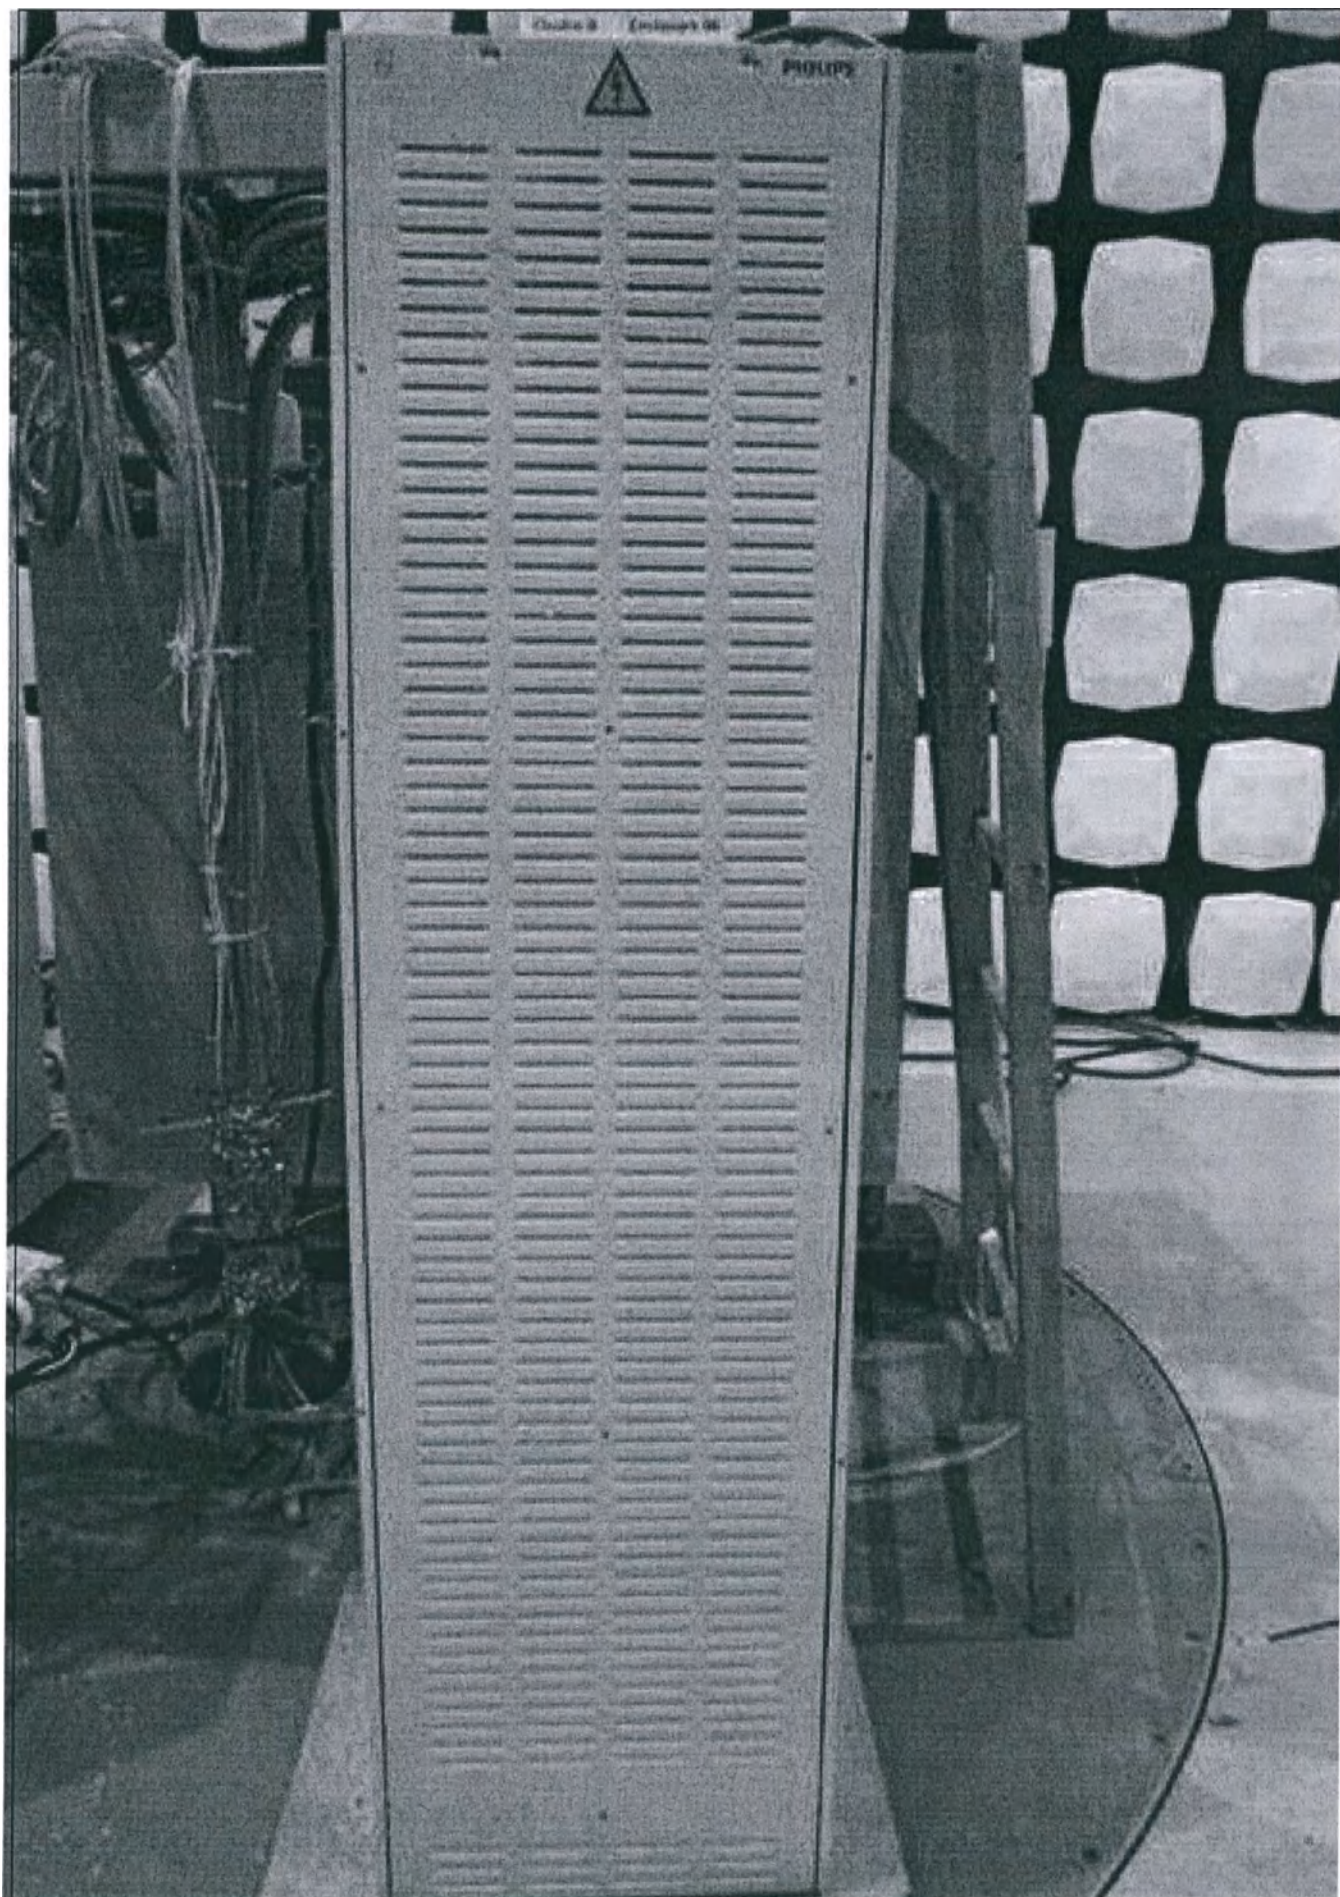


7.6. Распределительный щит.

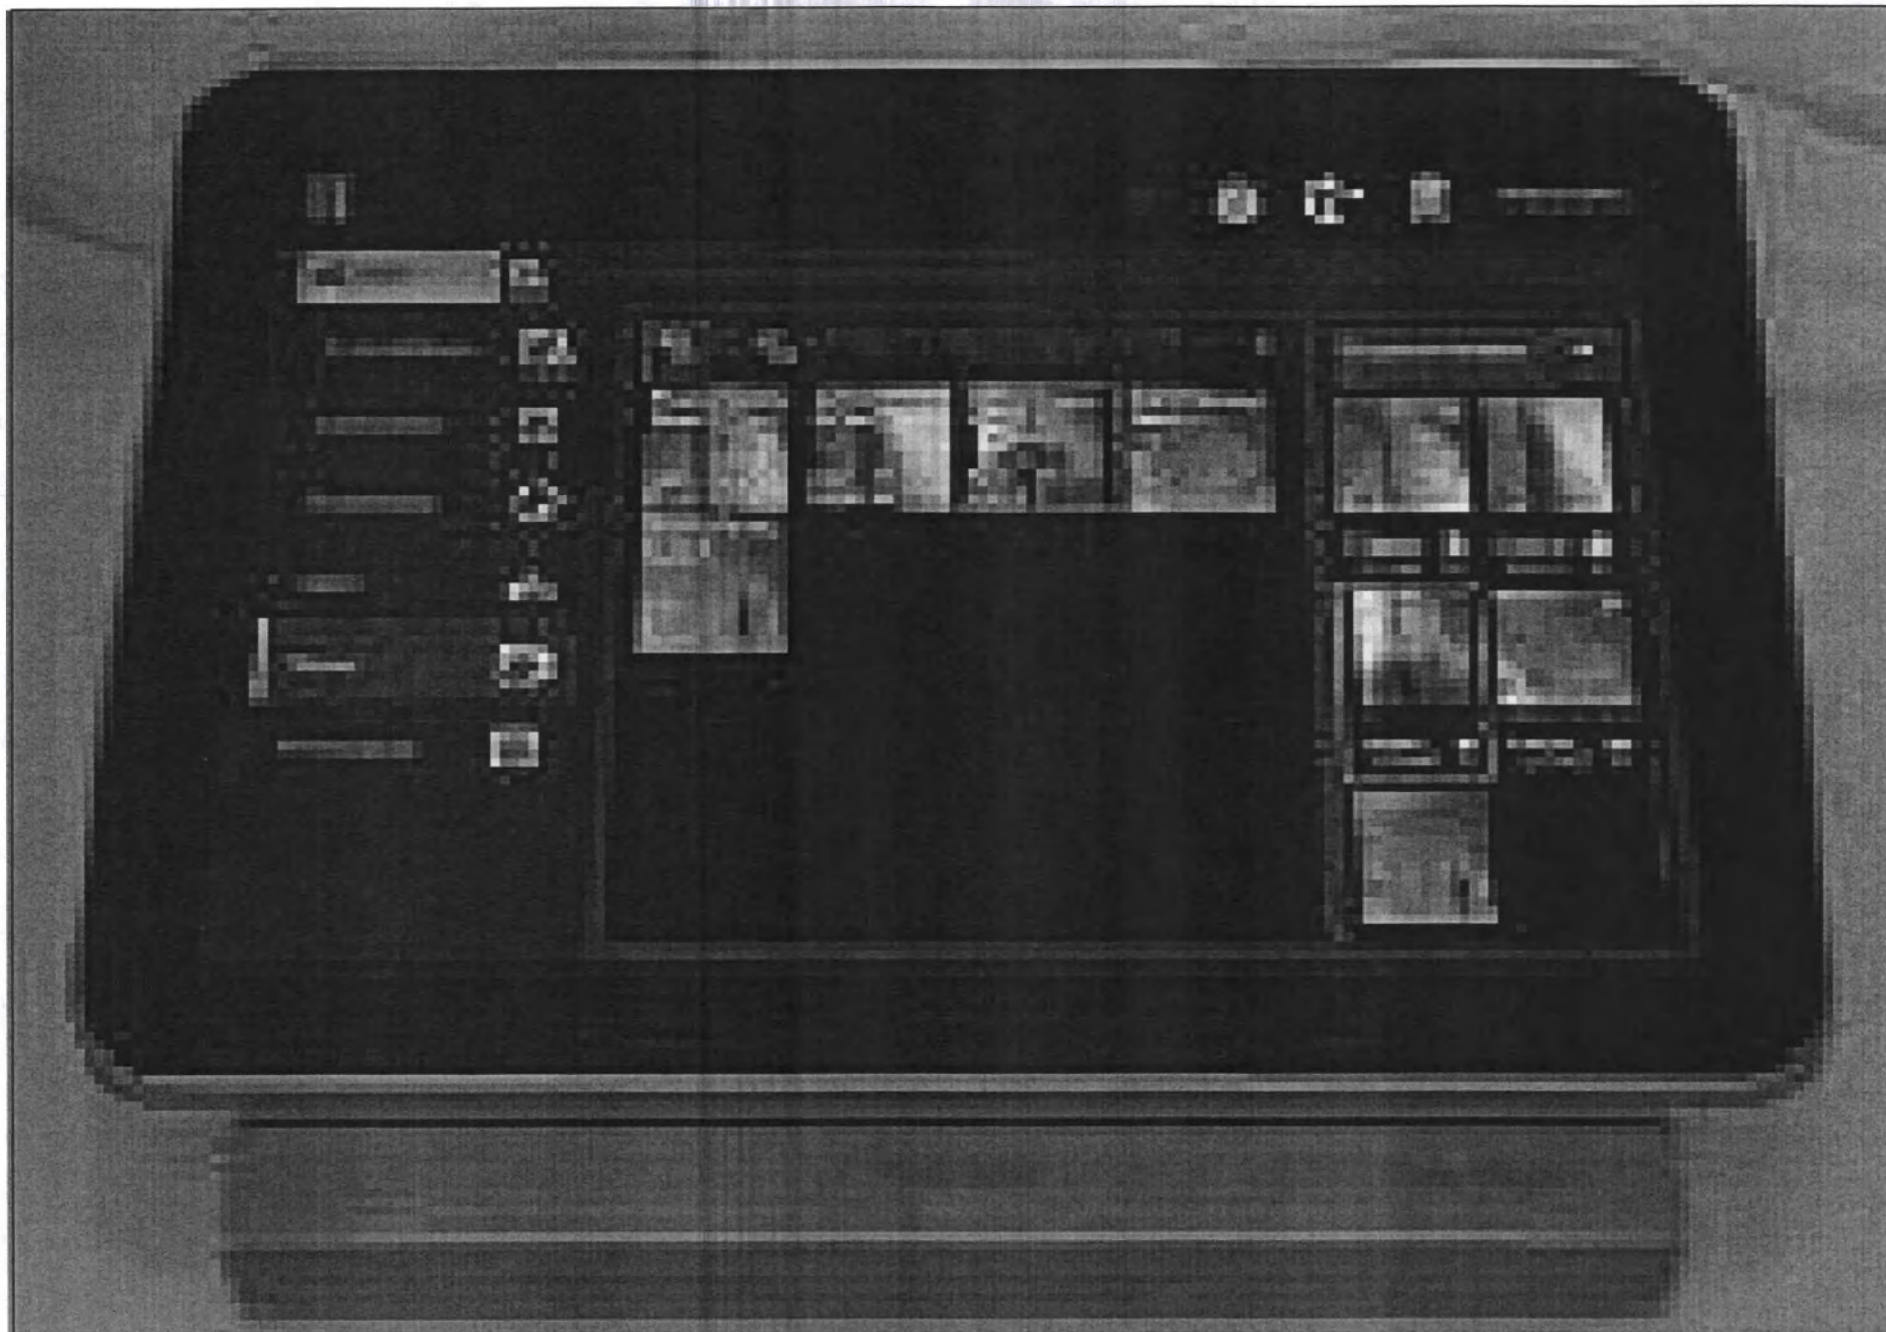


8. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

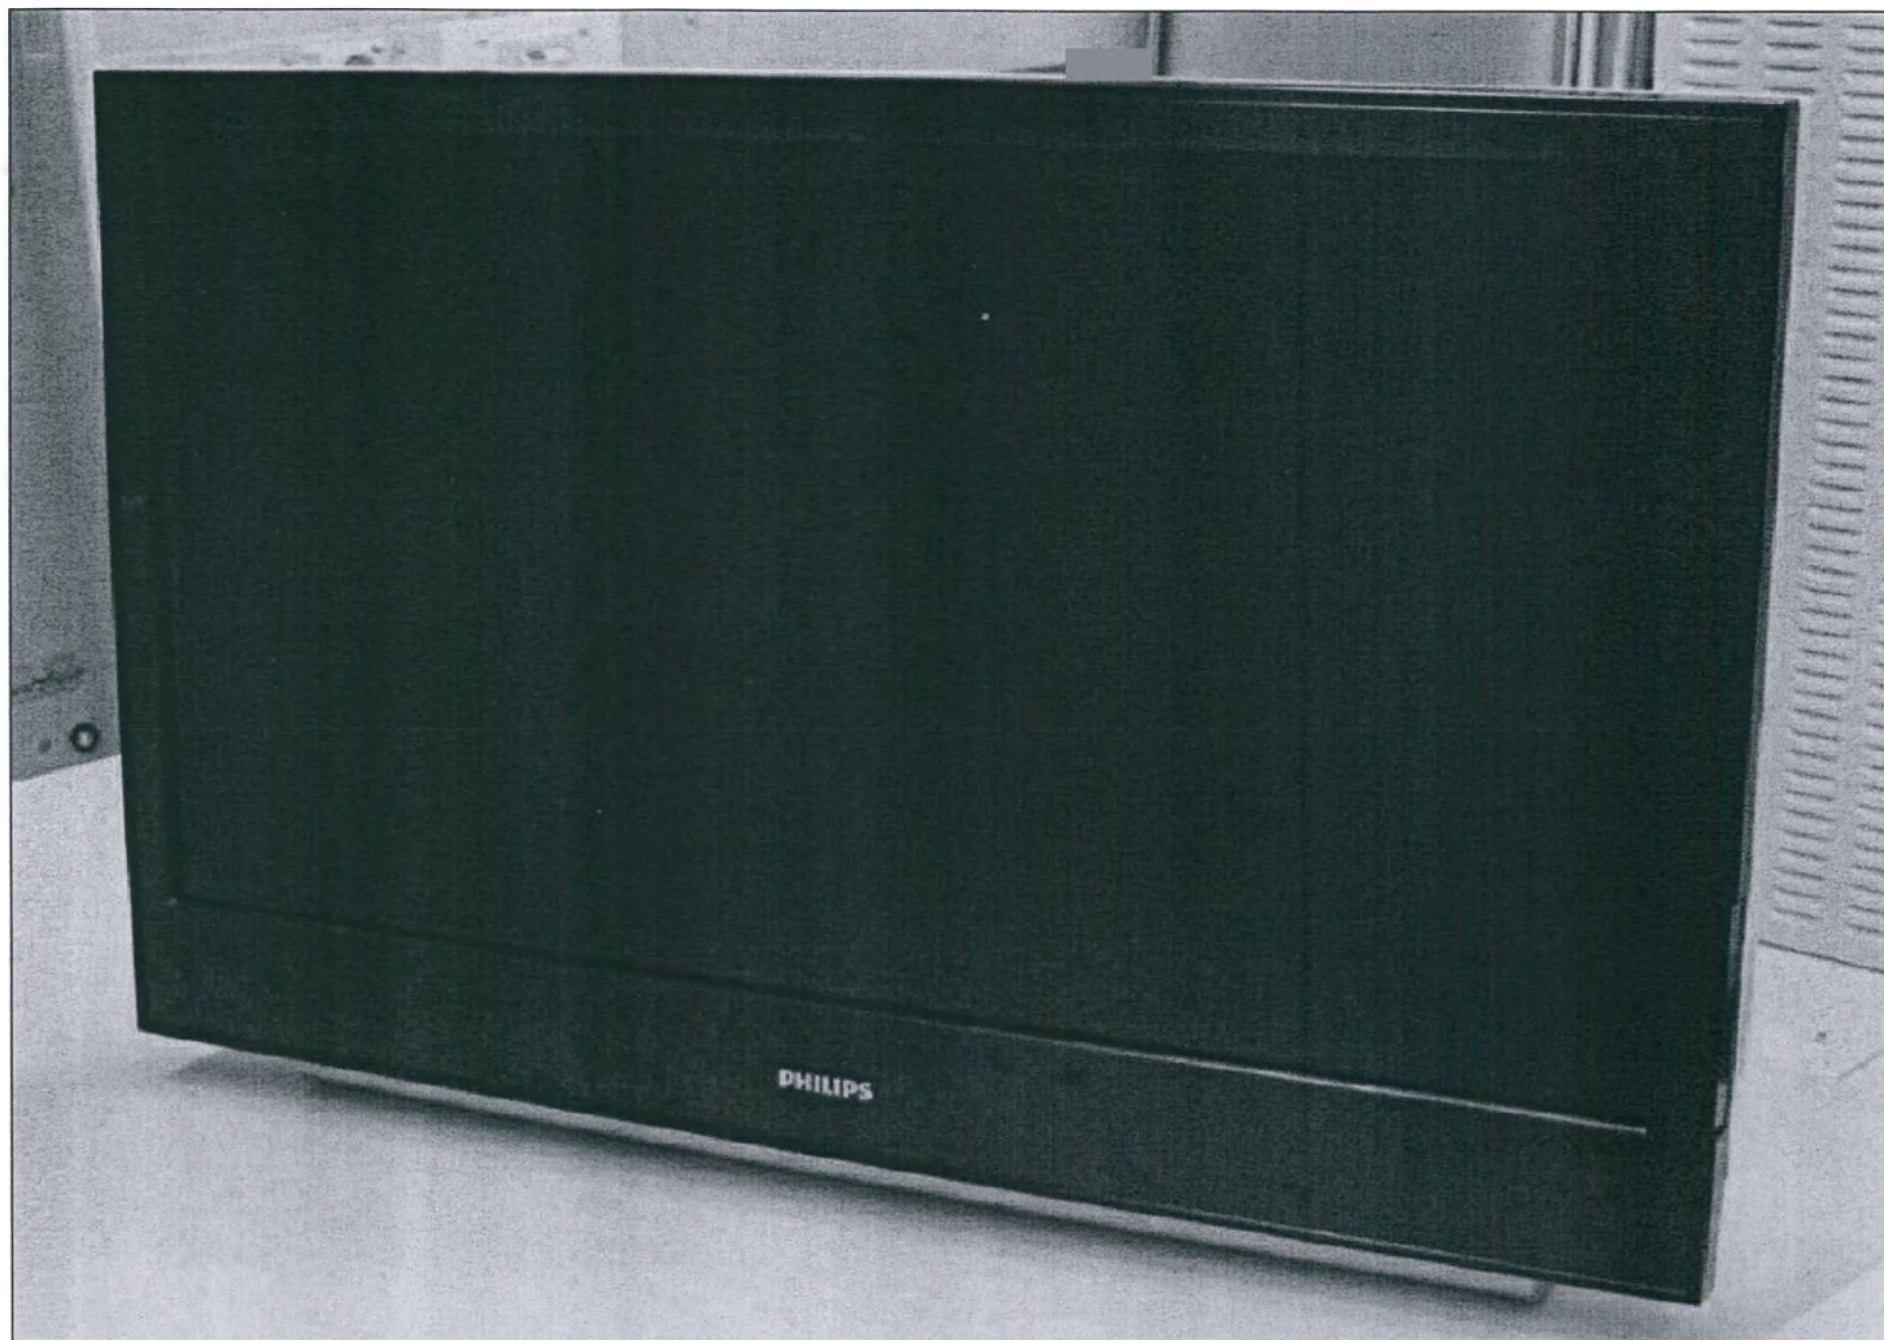

9. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

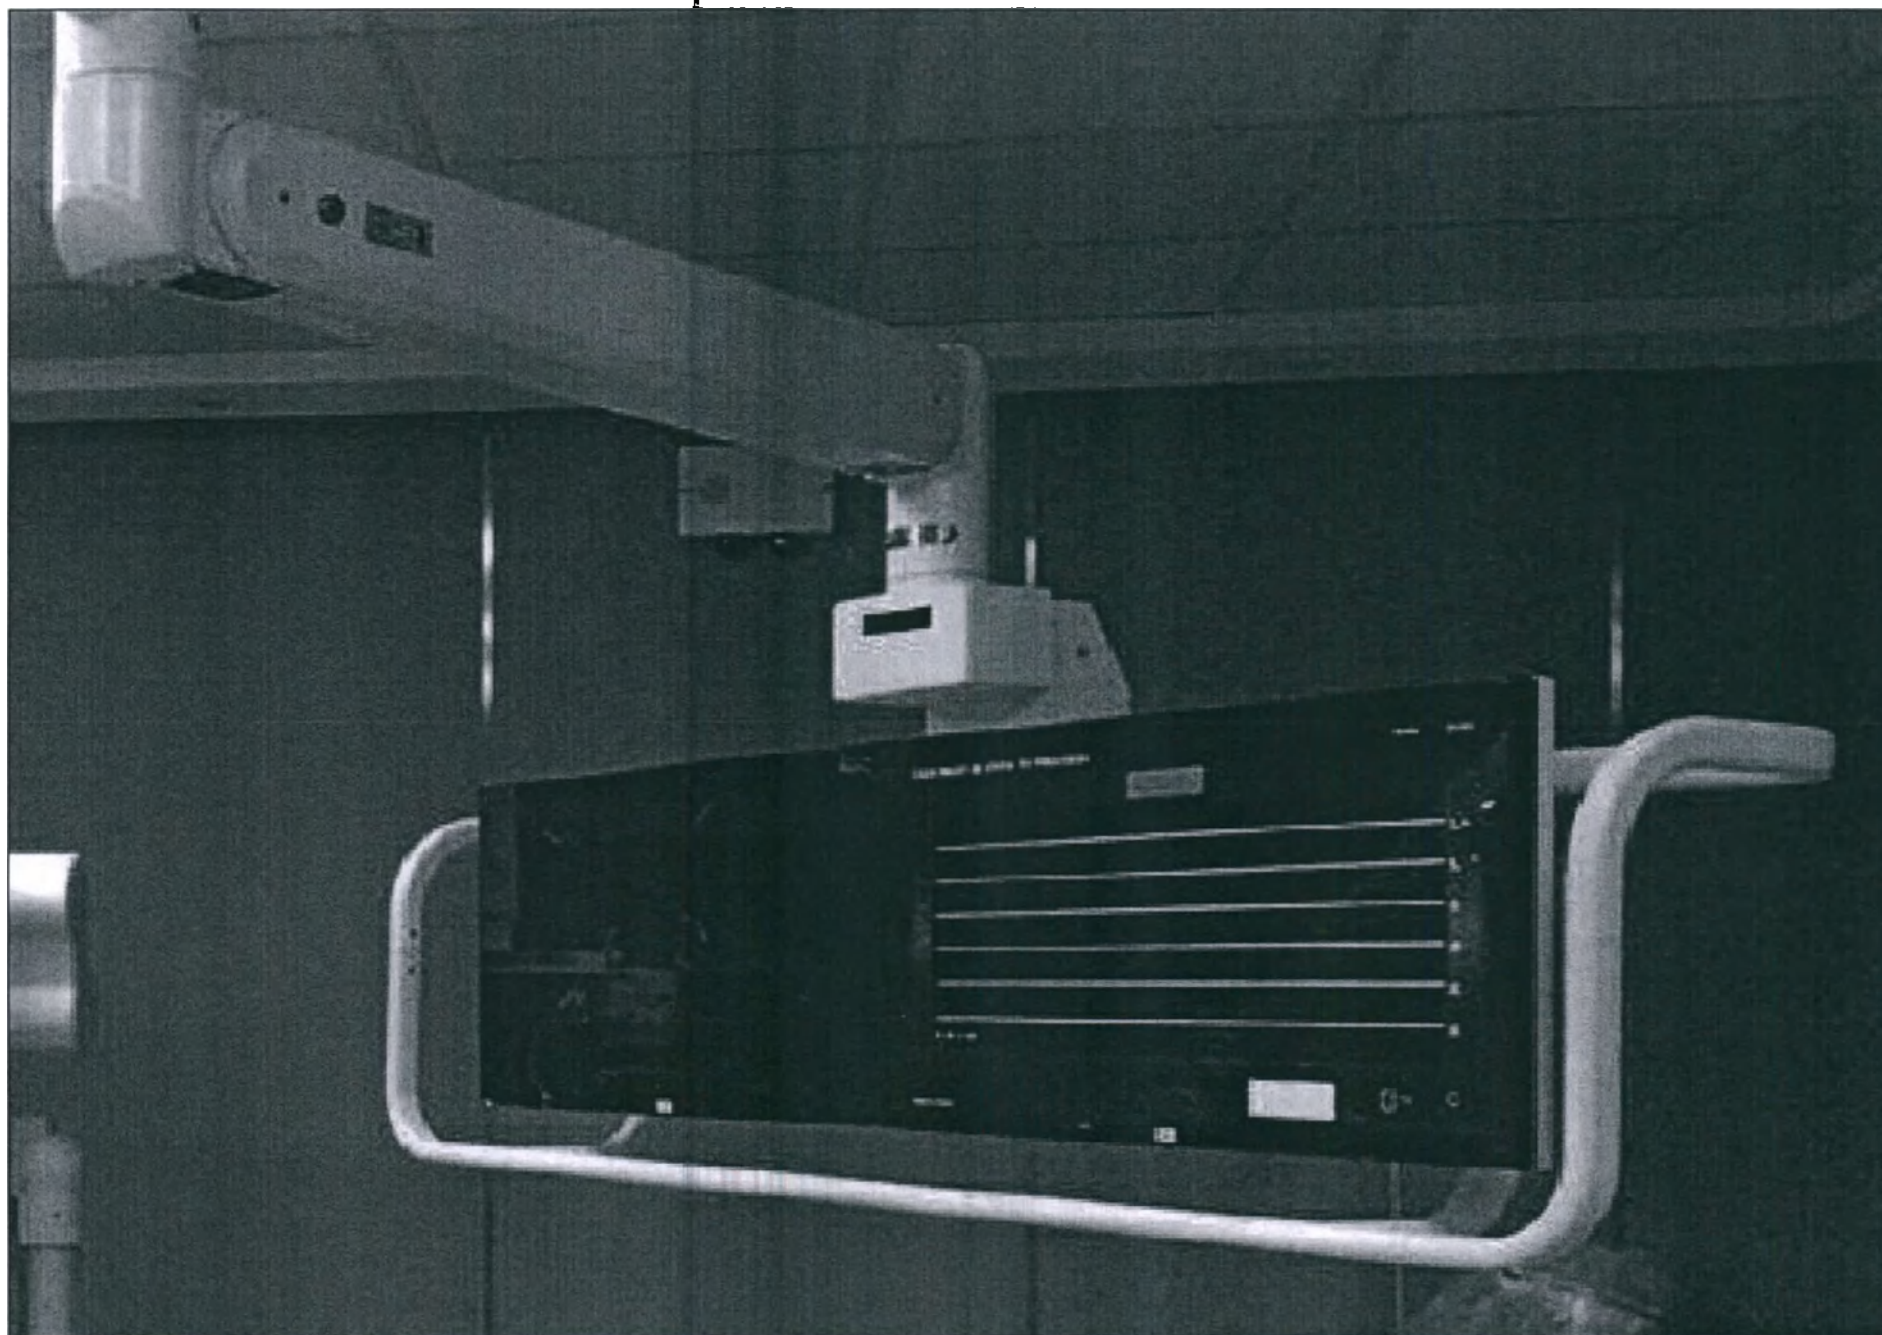


10. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

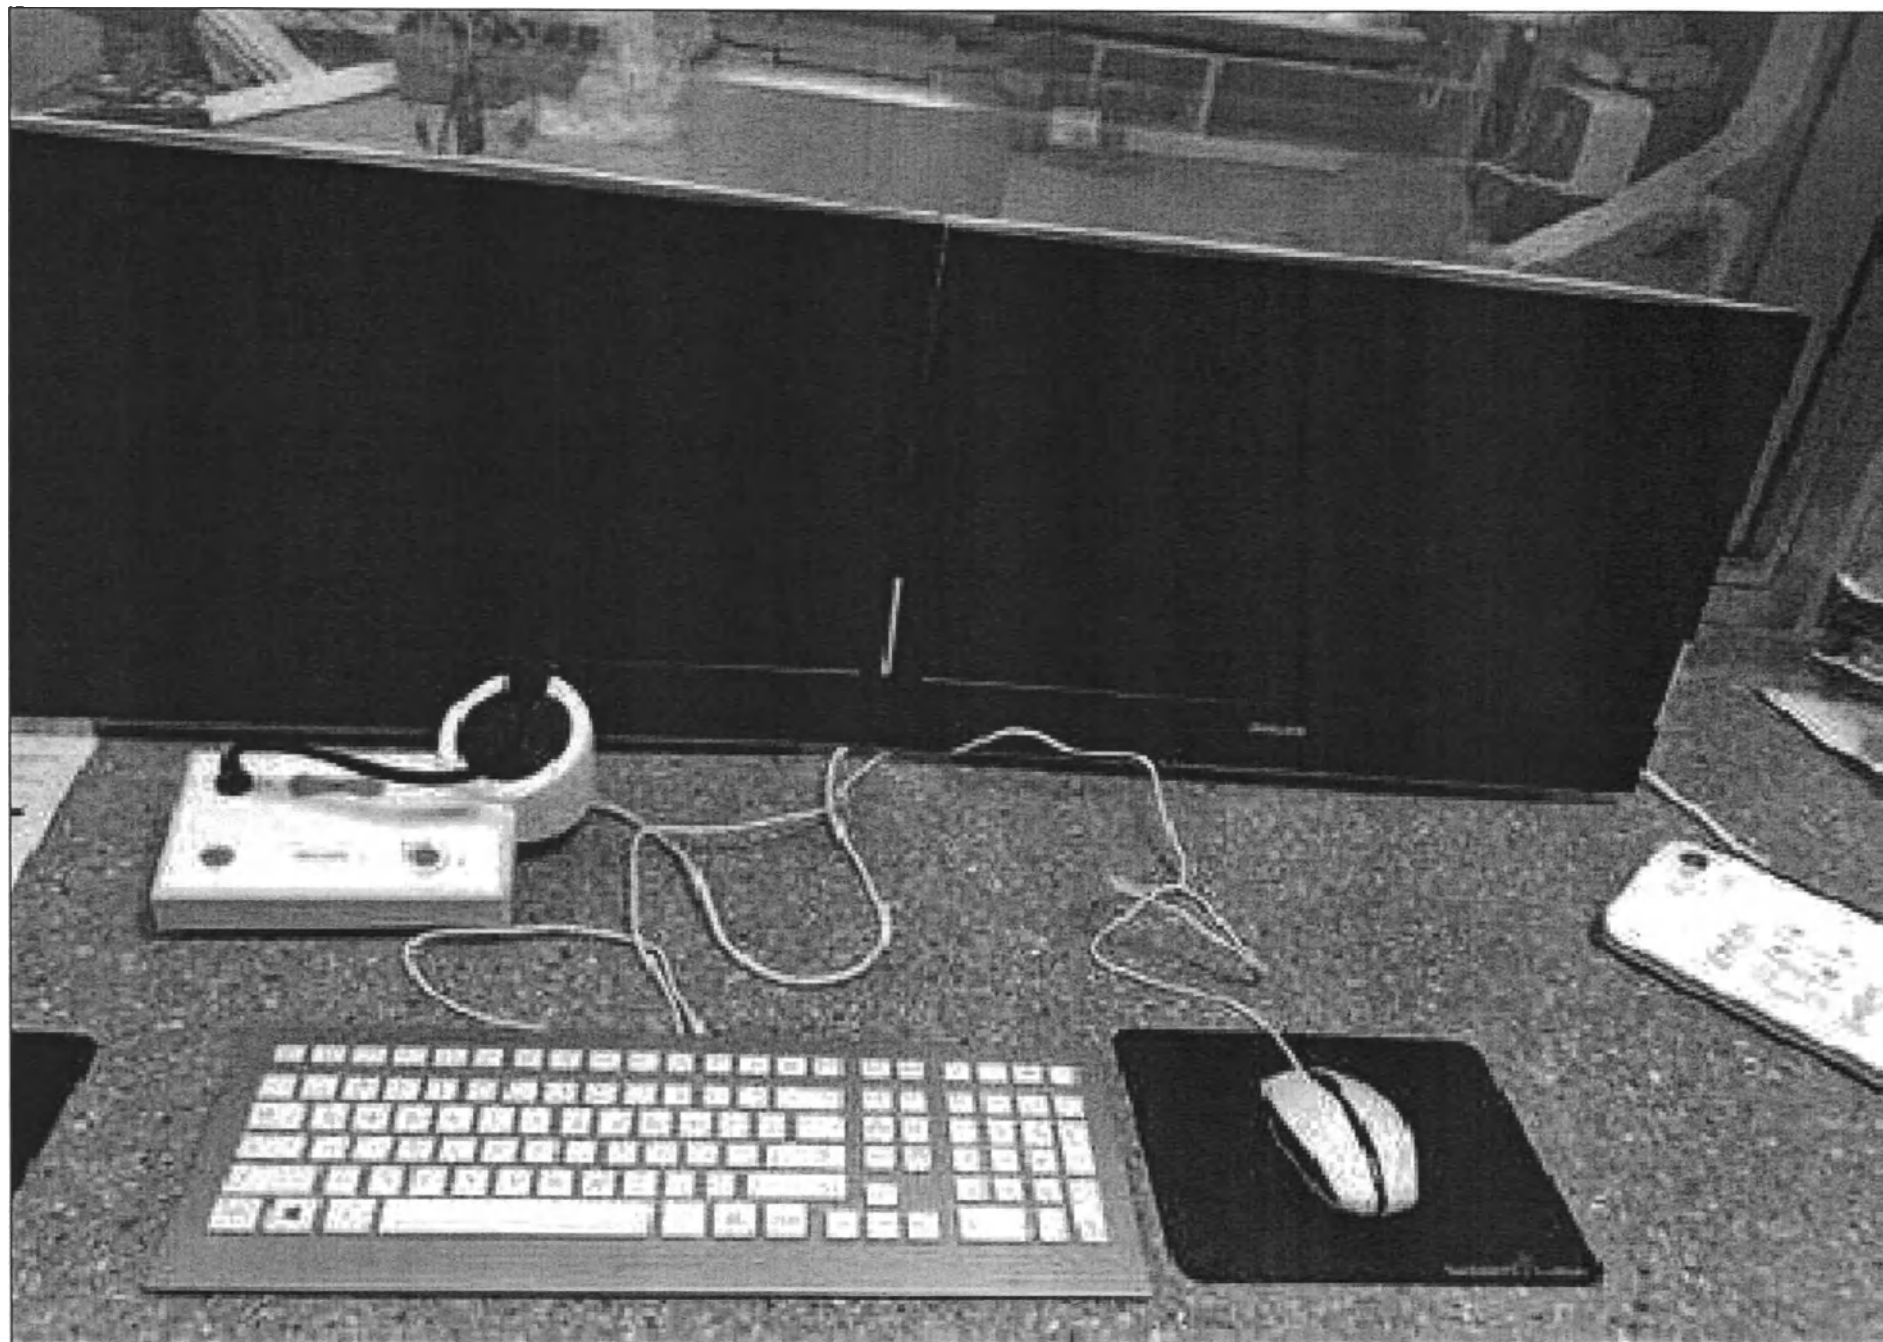


11.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.



11.6. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

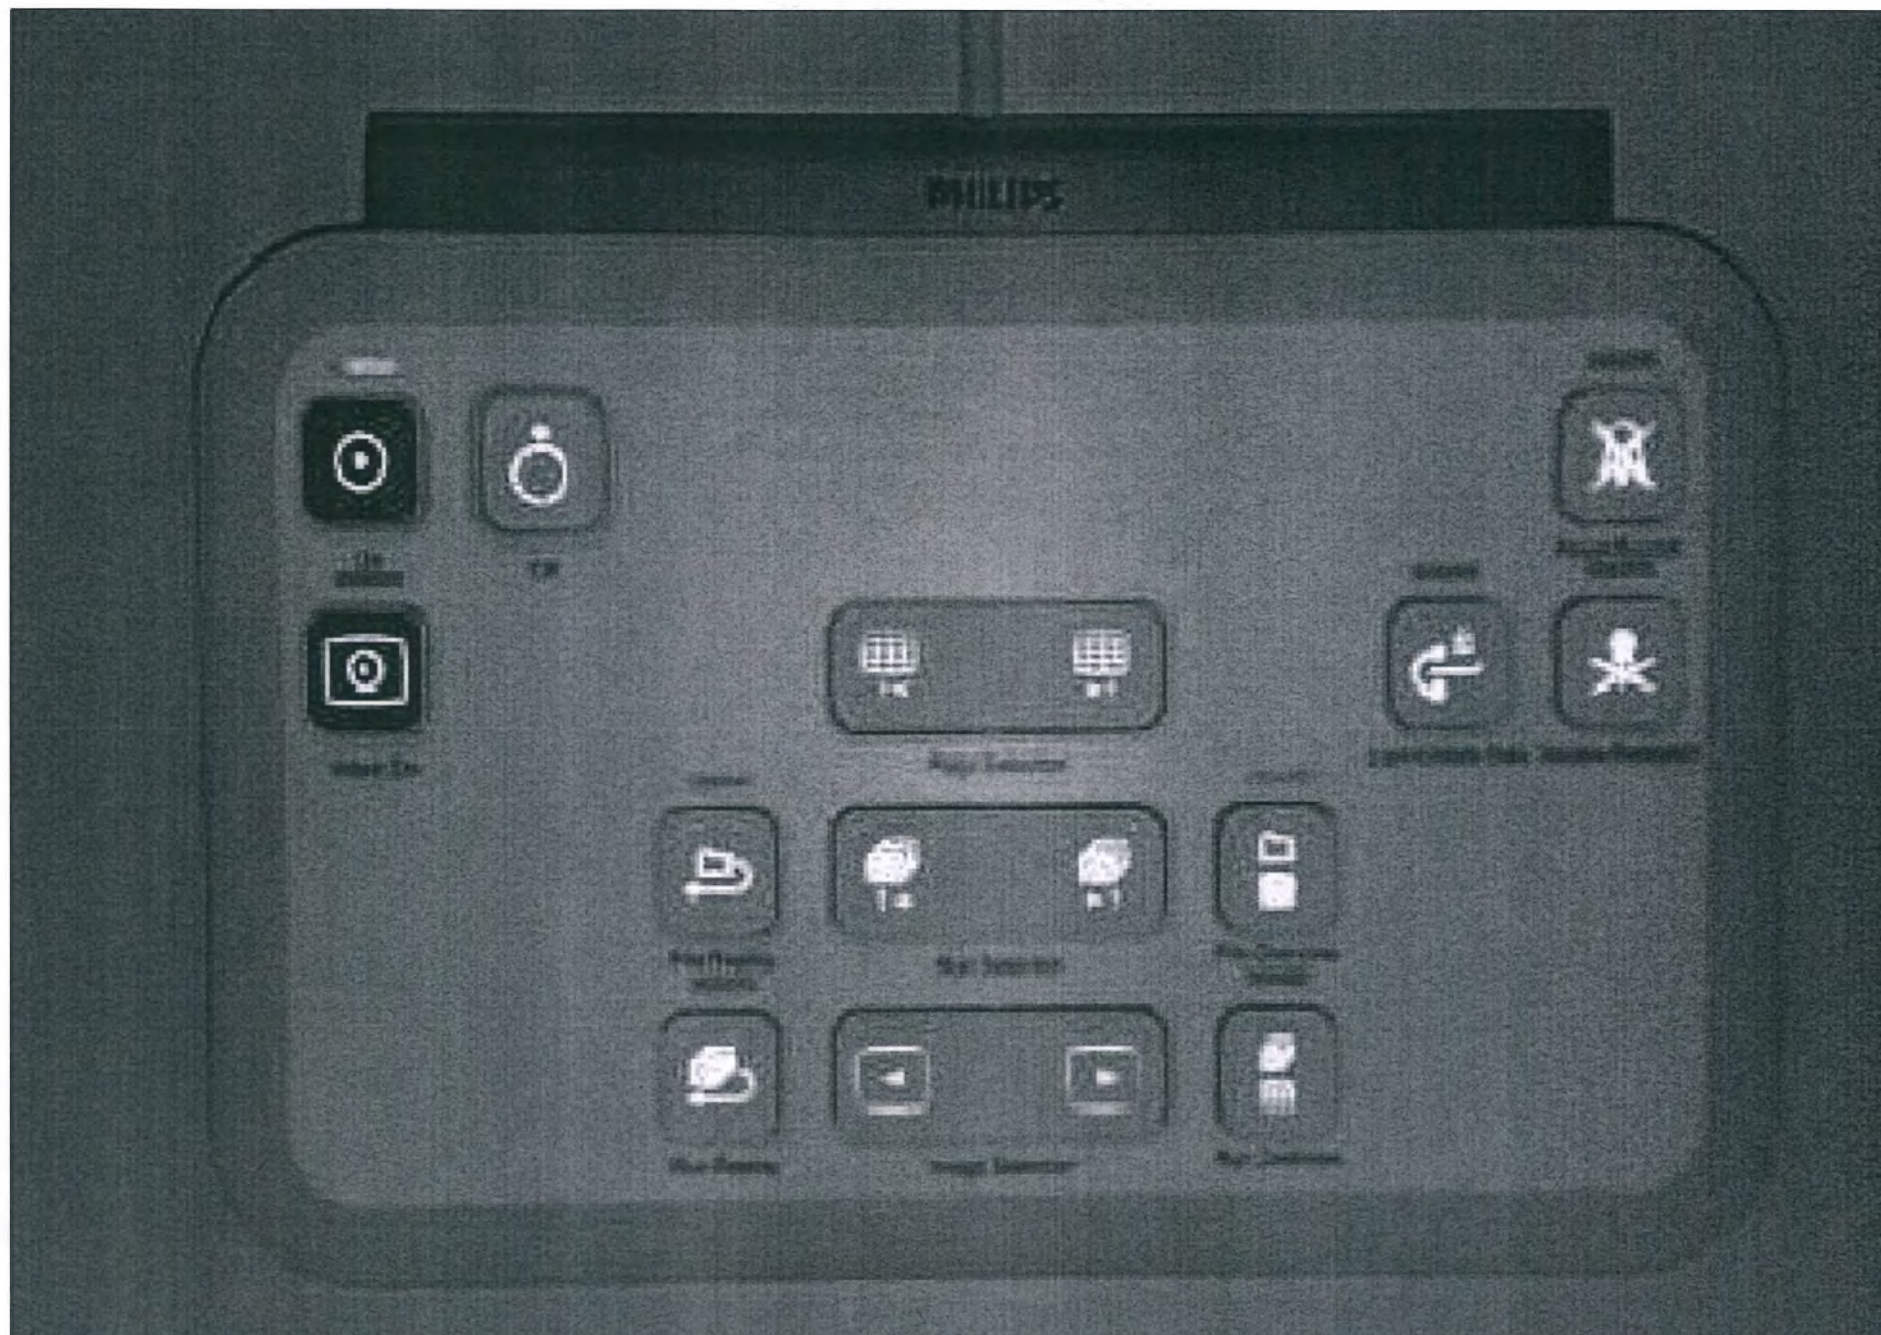


11.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

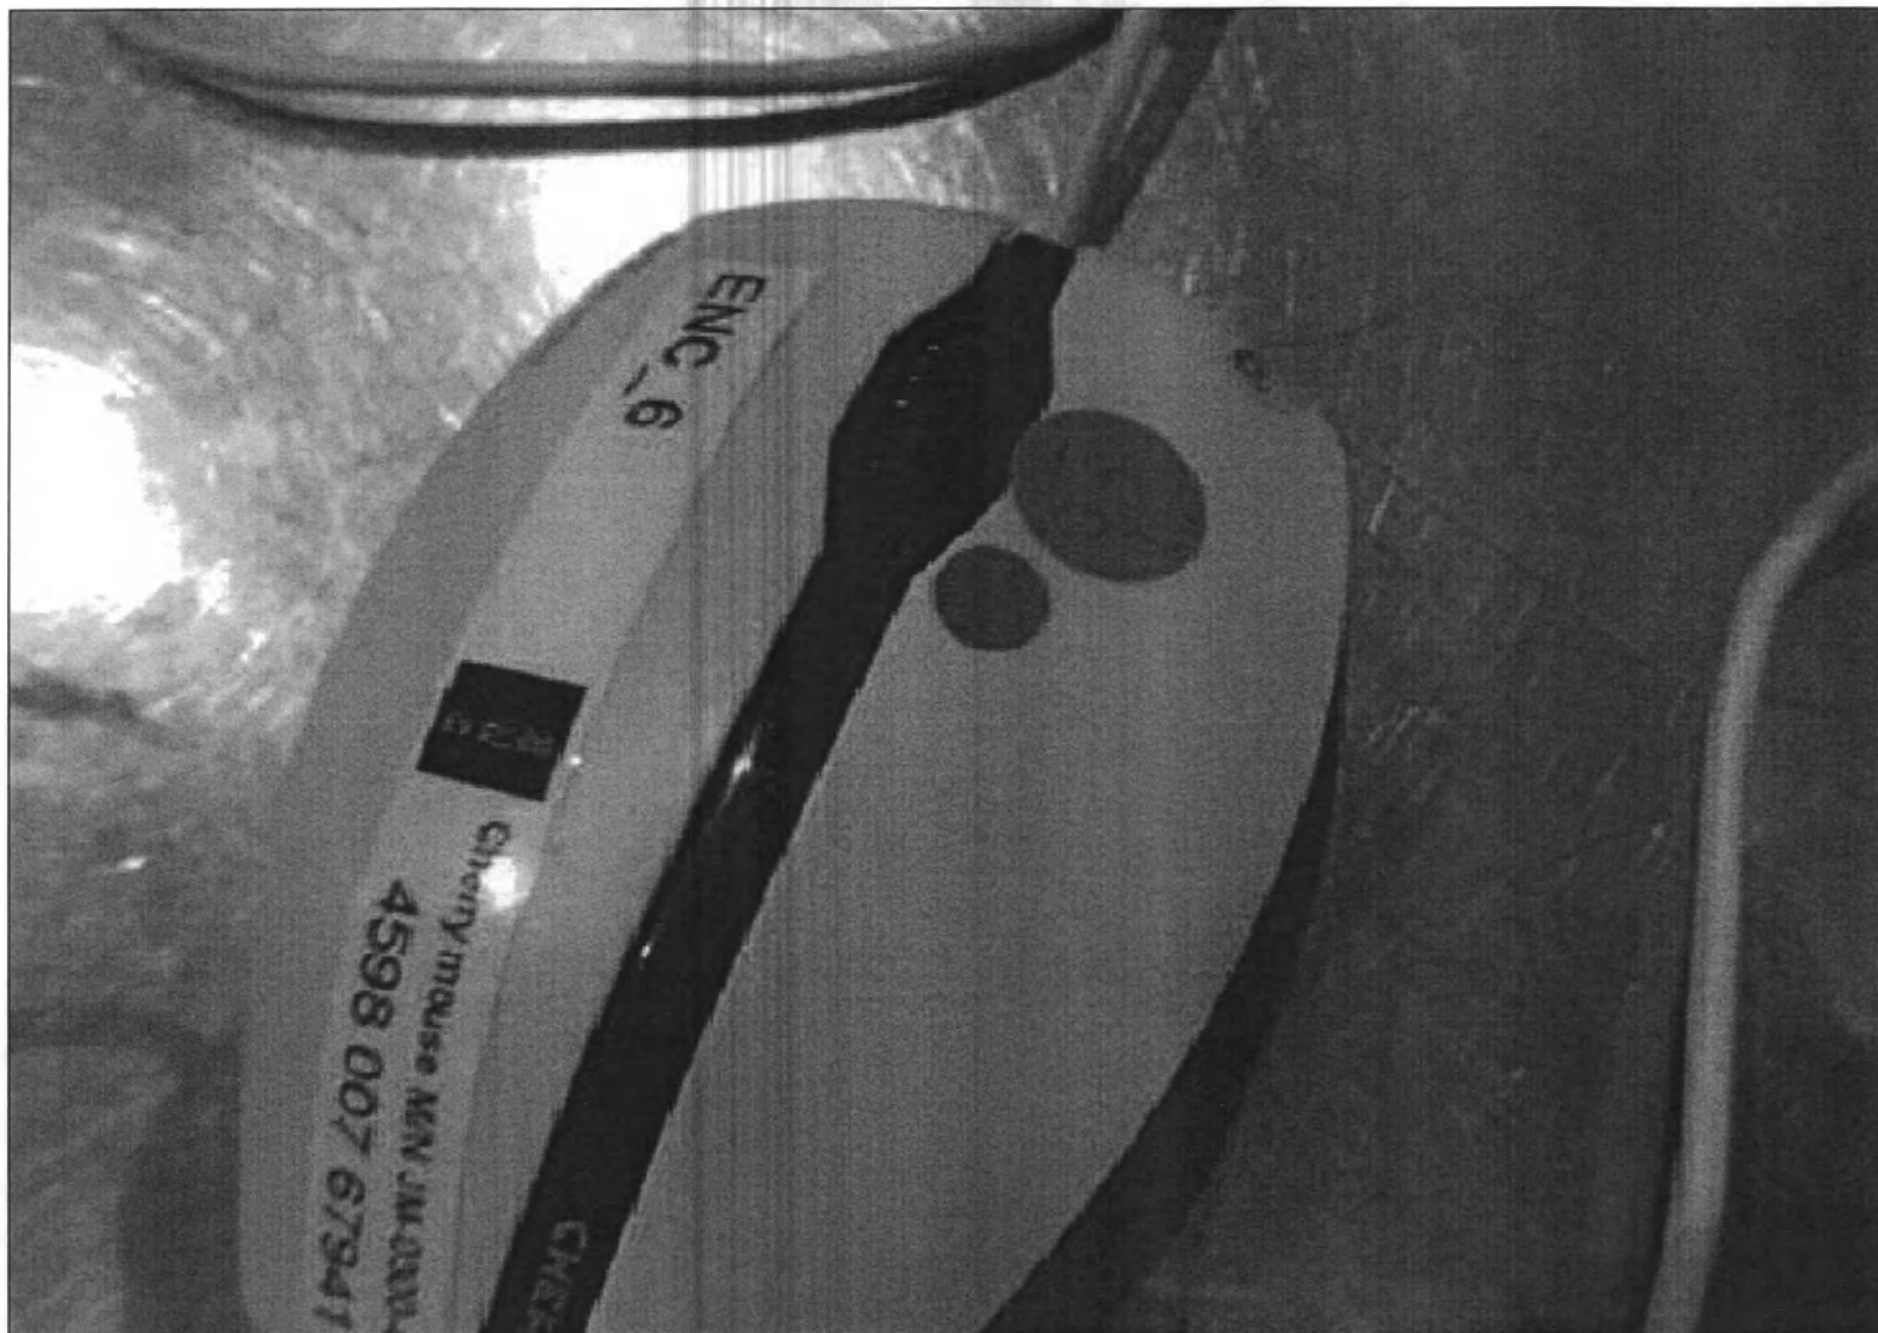


11.2. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; **Мышь**; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.




11.д. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; **Мышь**; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

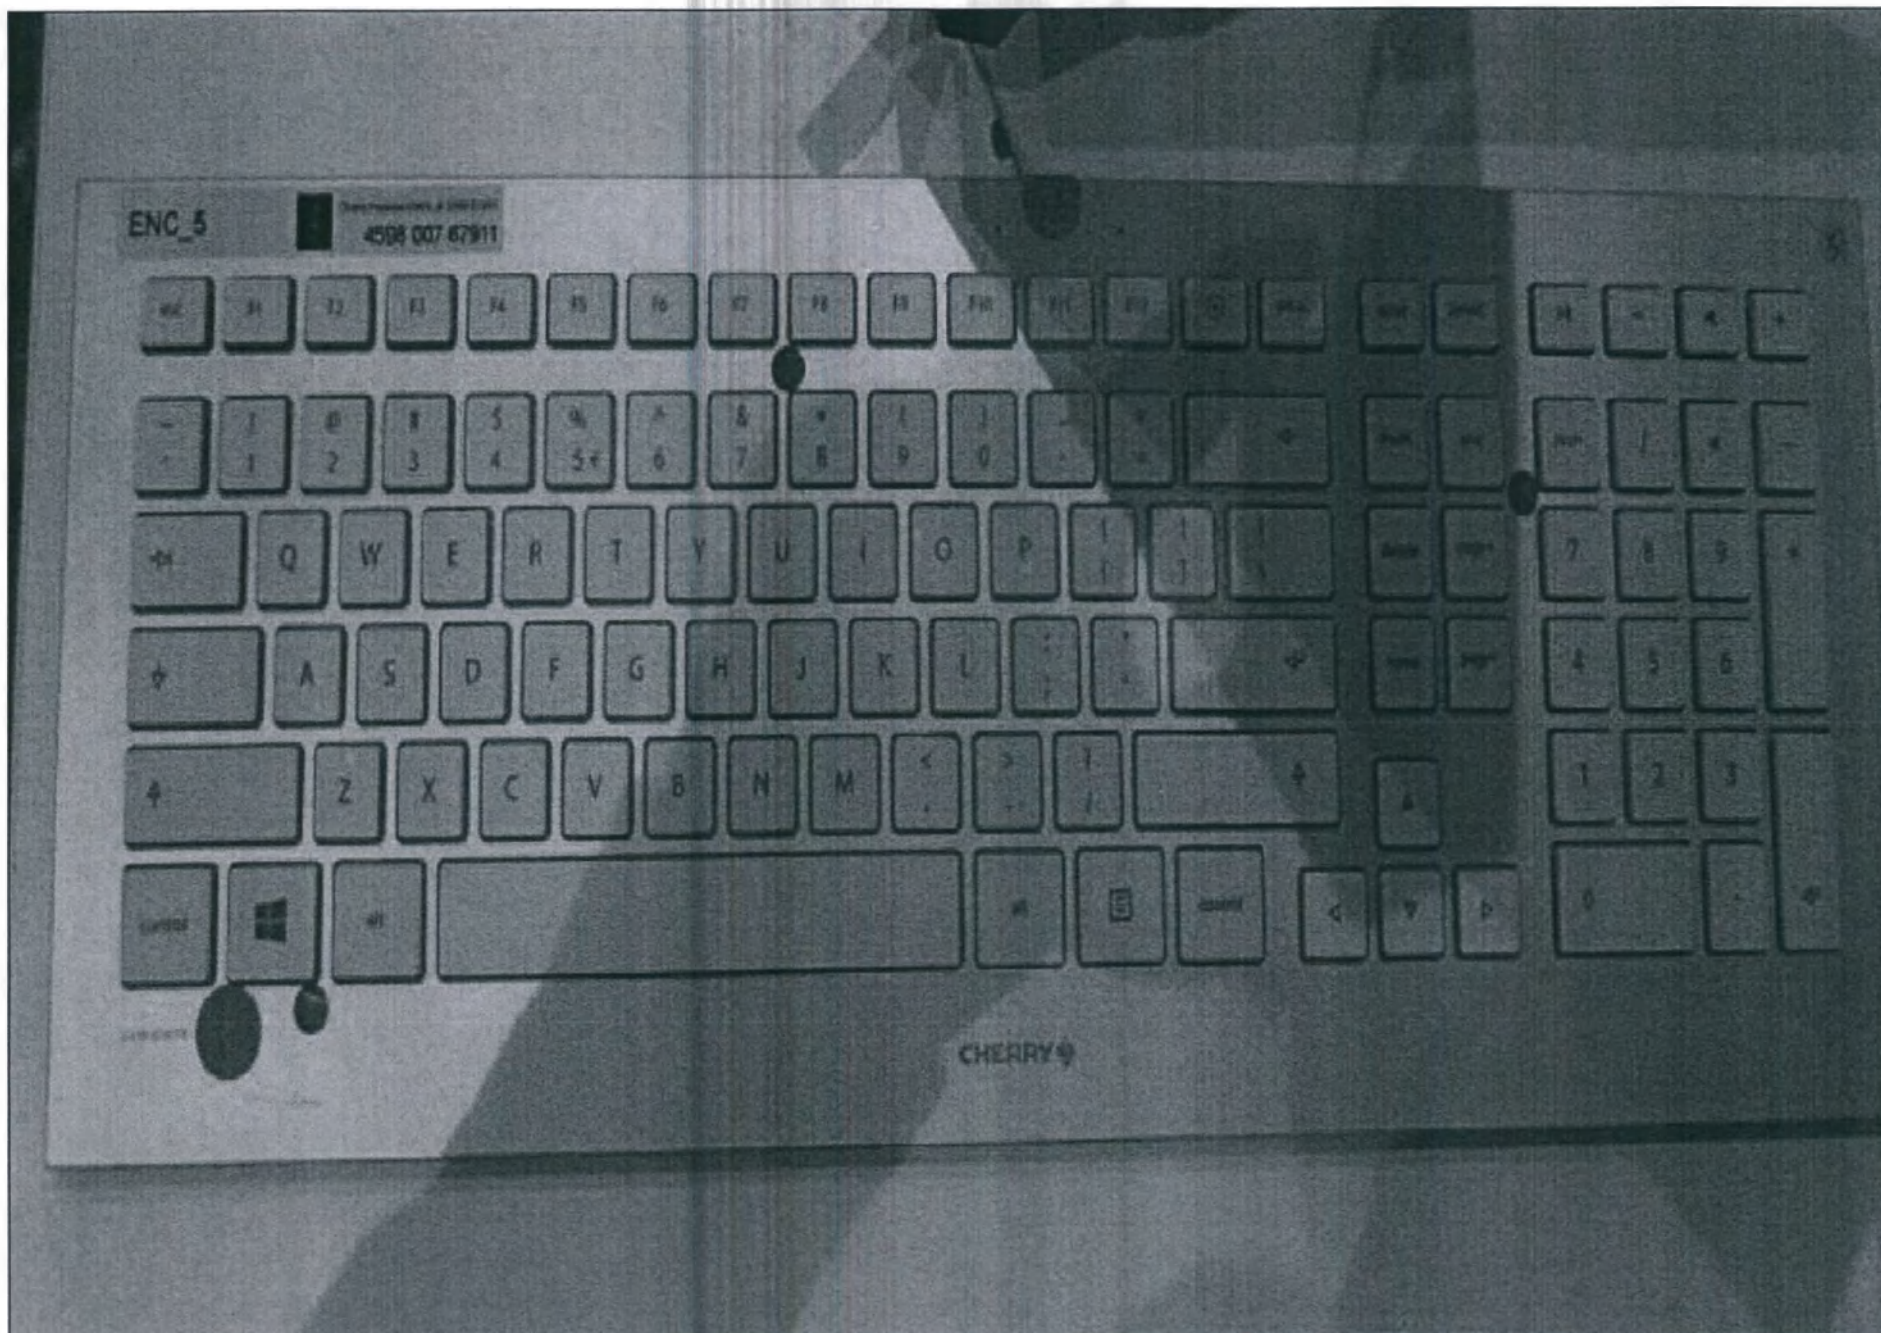


11.е. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 1.2 и выше.

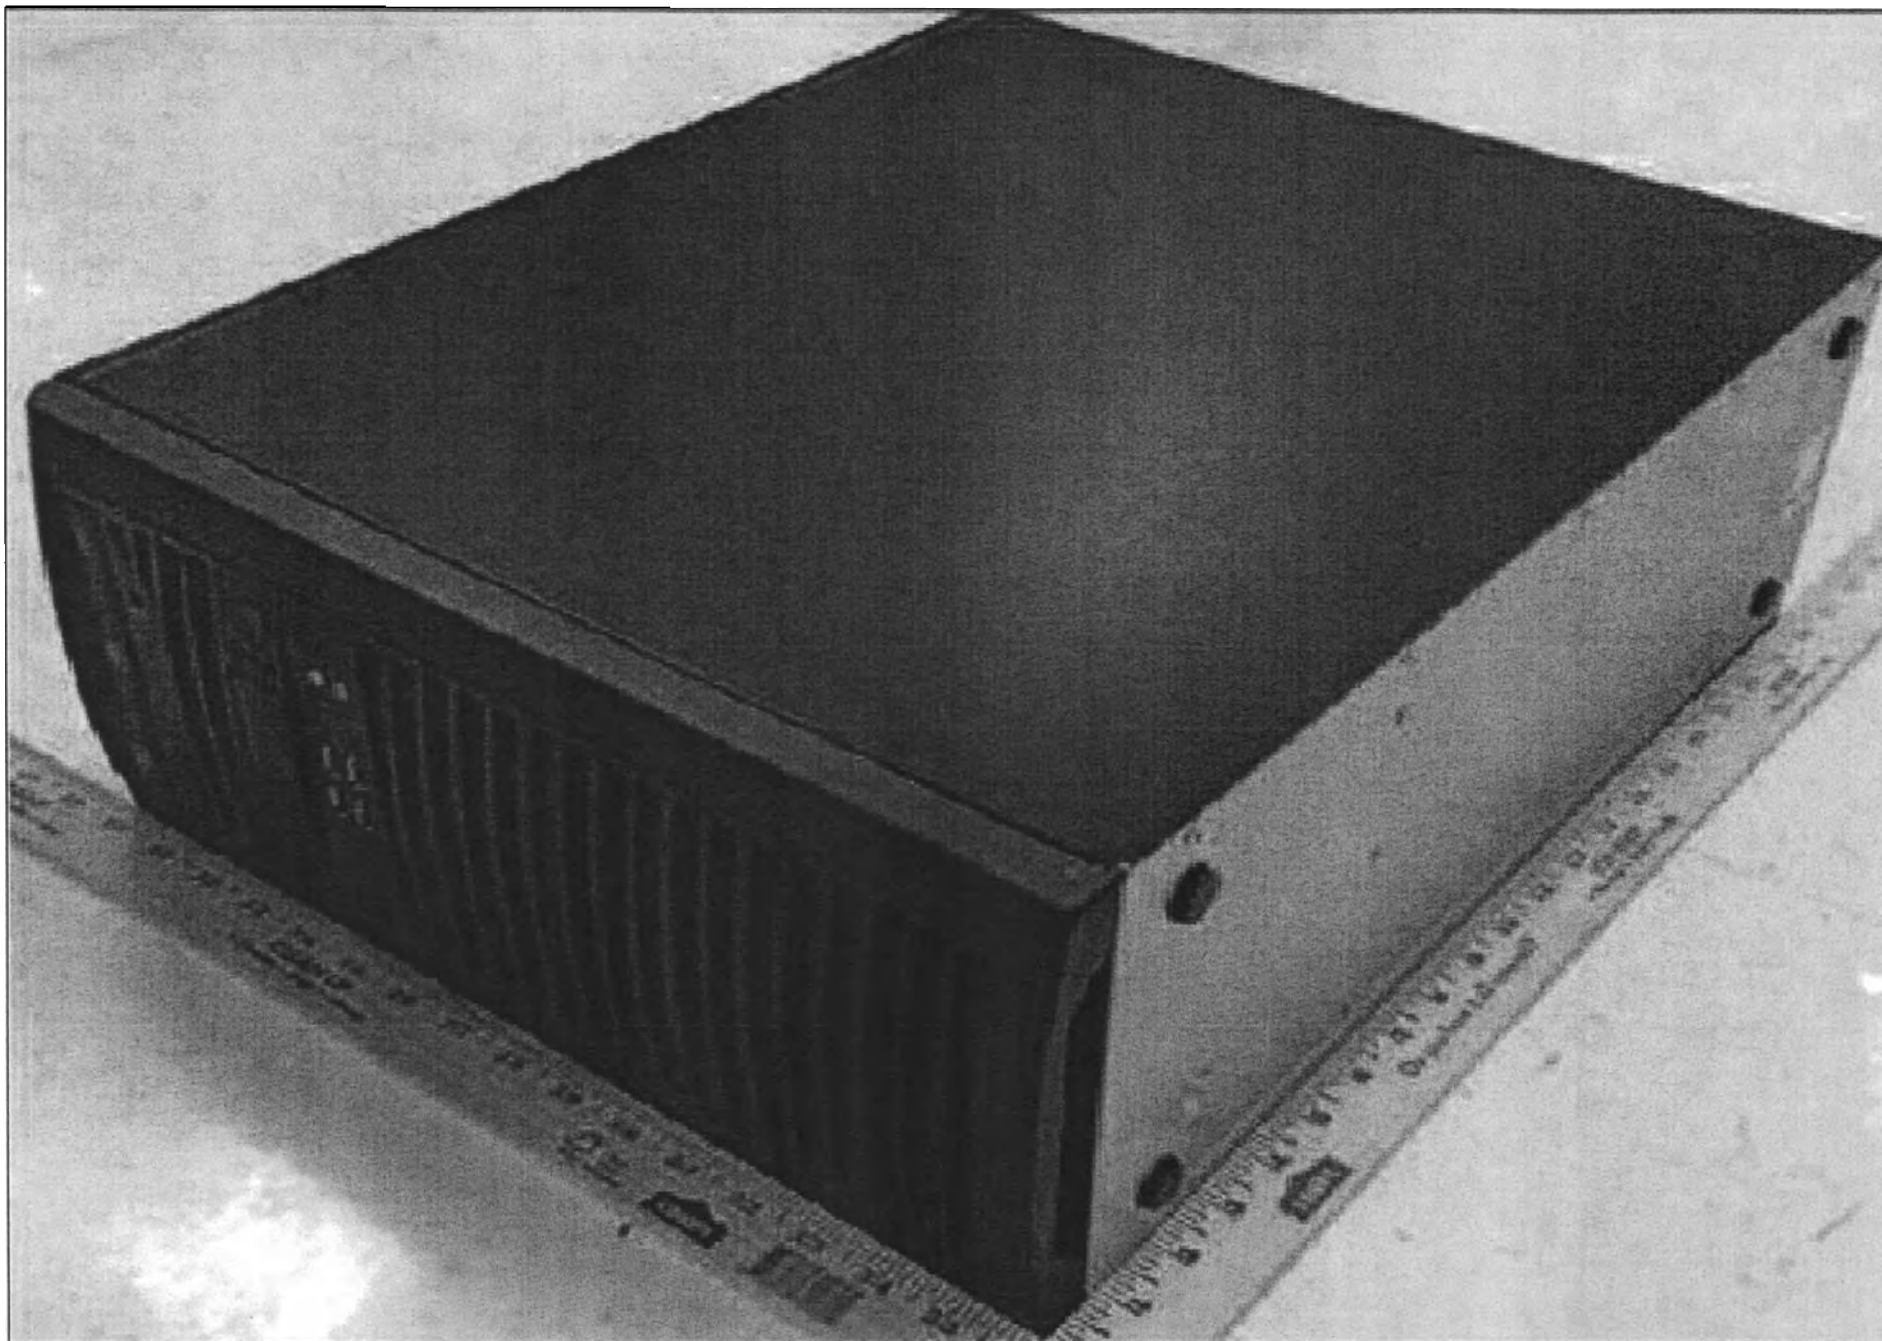

11.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Aziglon версия 1.2 и выше.

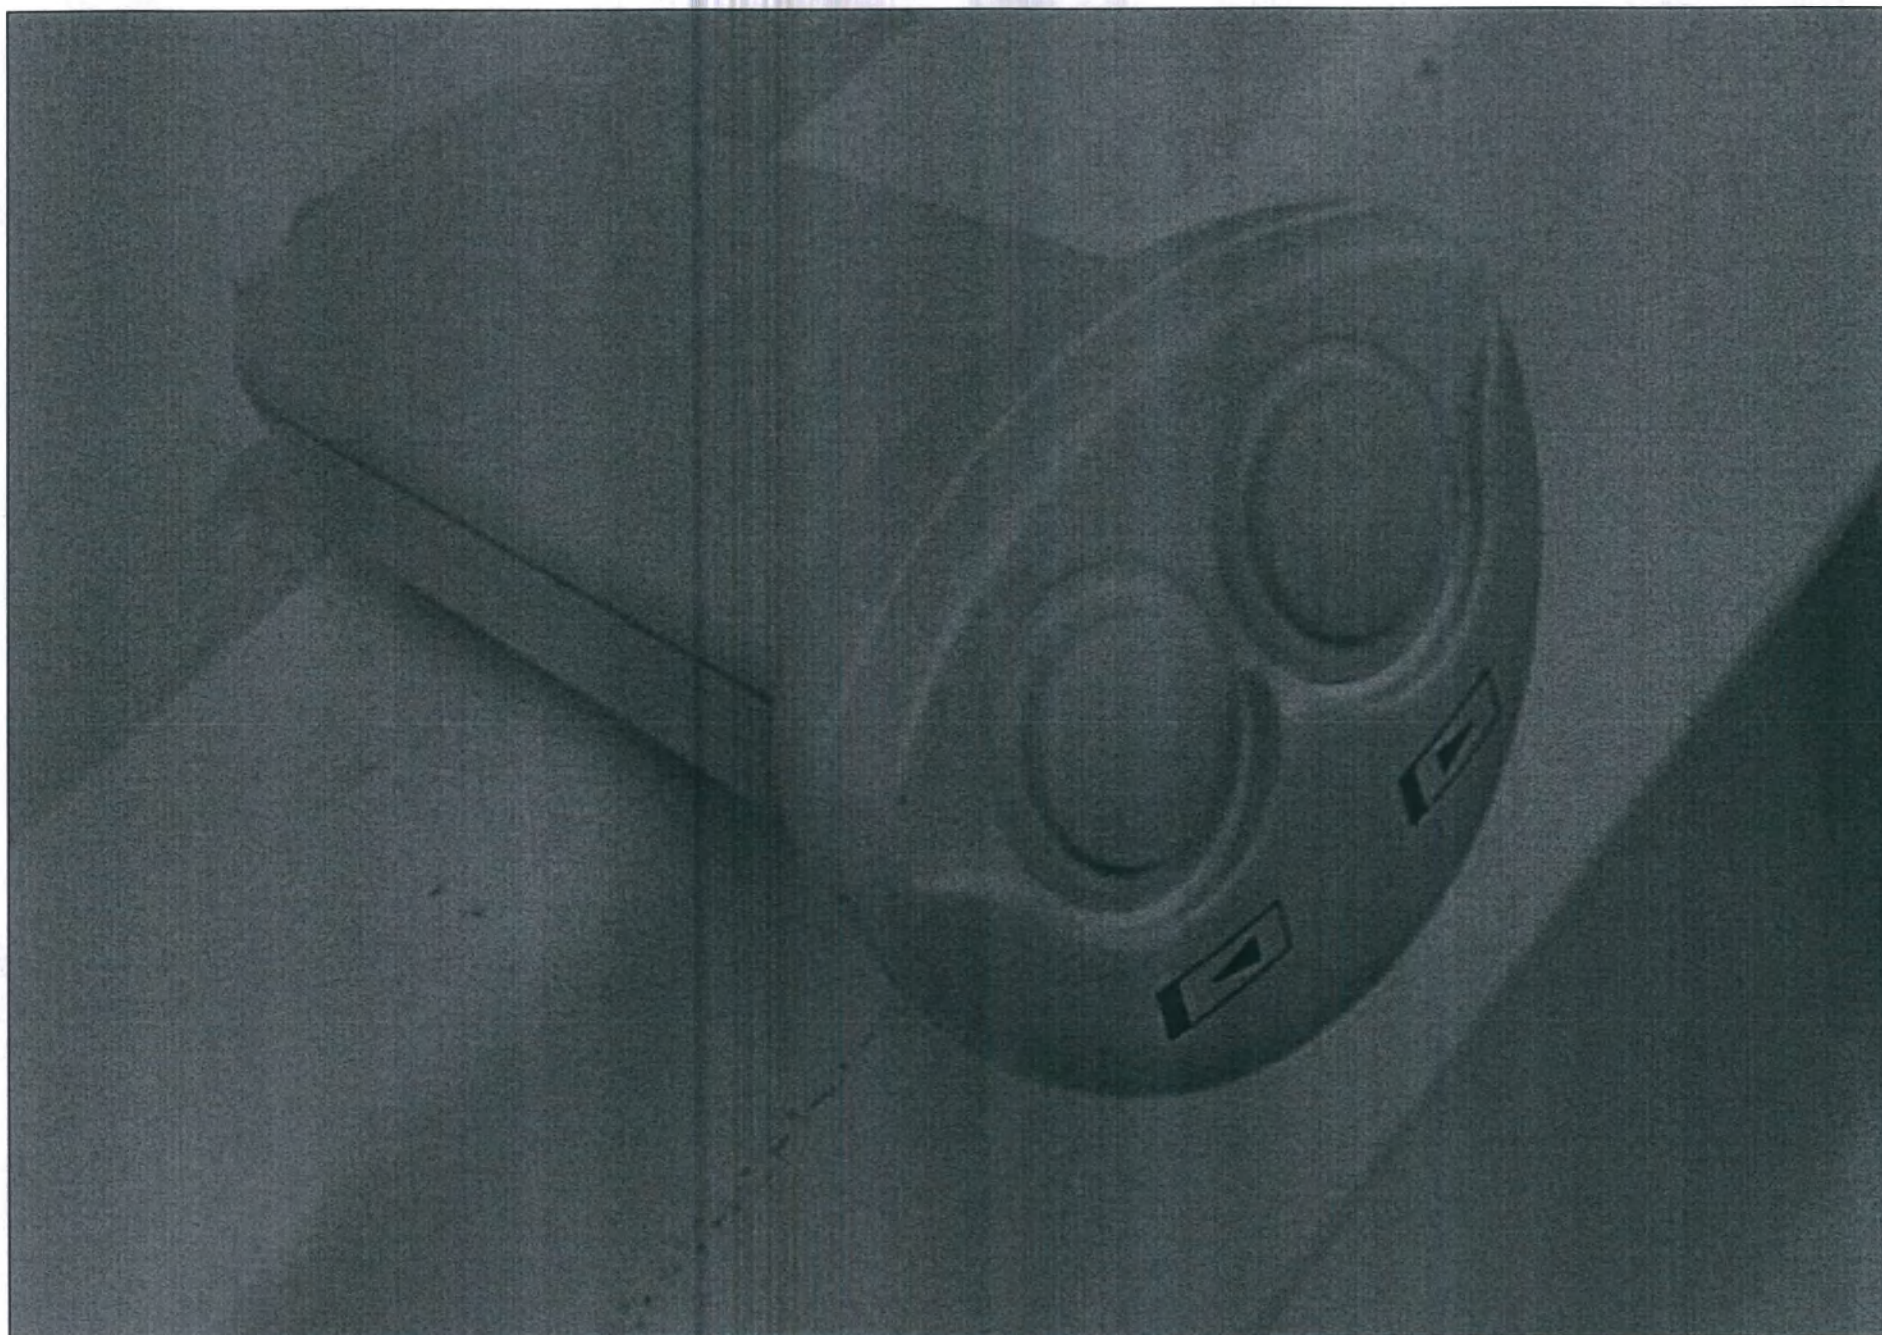


12. Ручной переключатель сдвига.

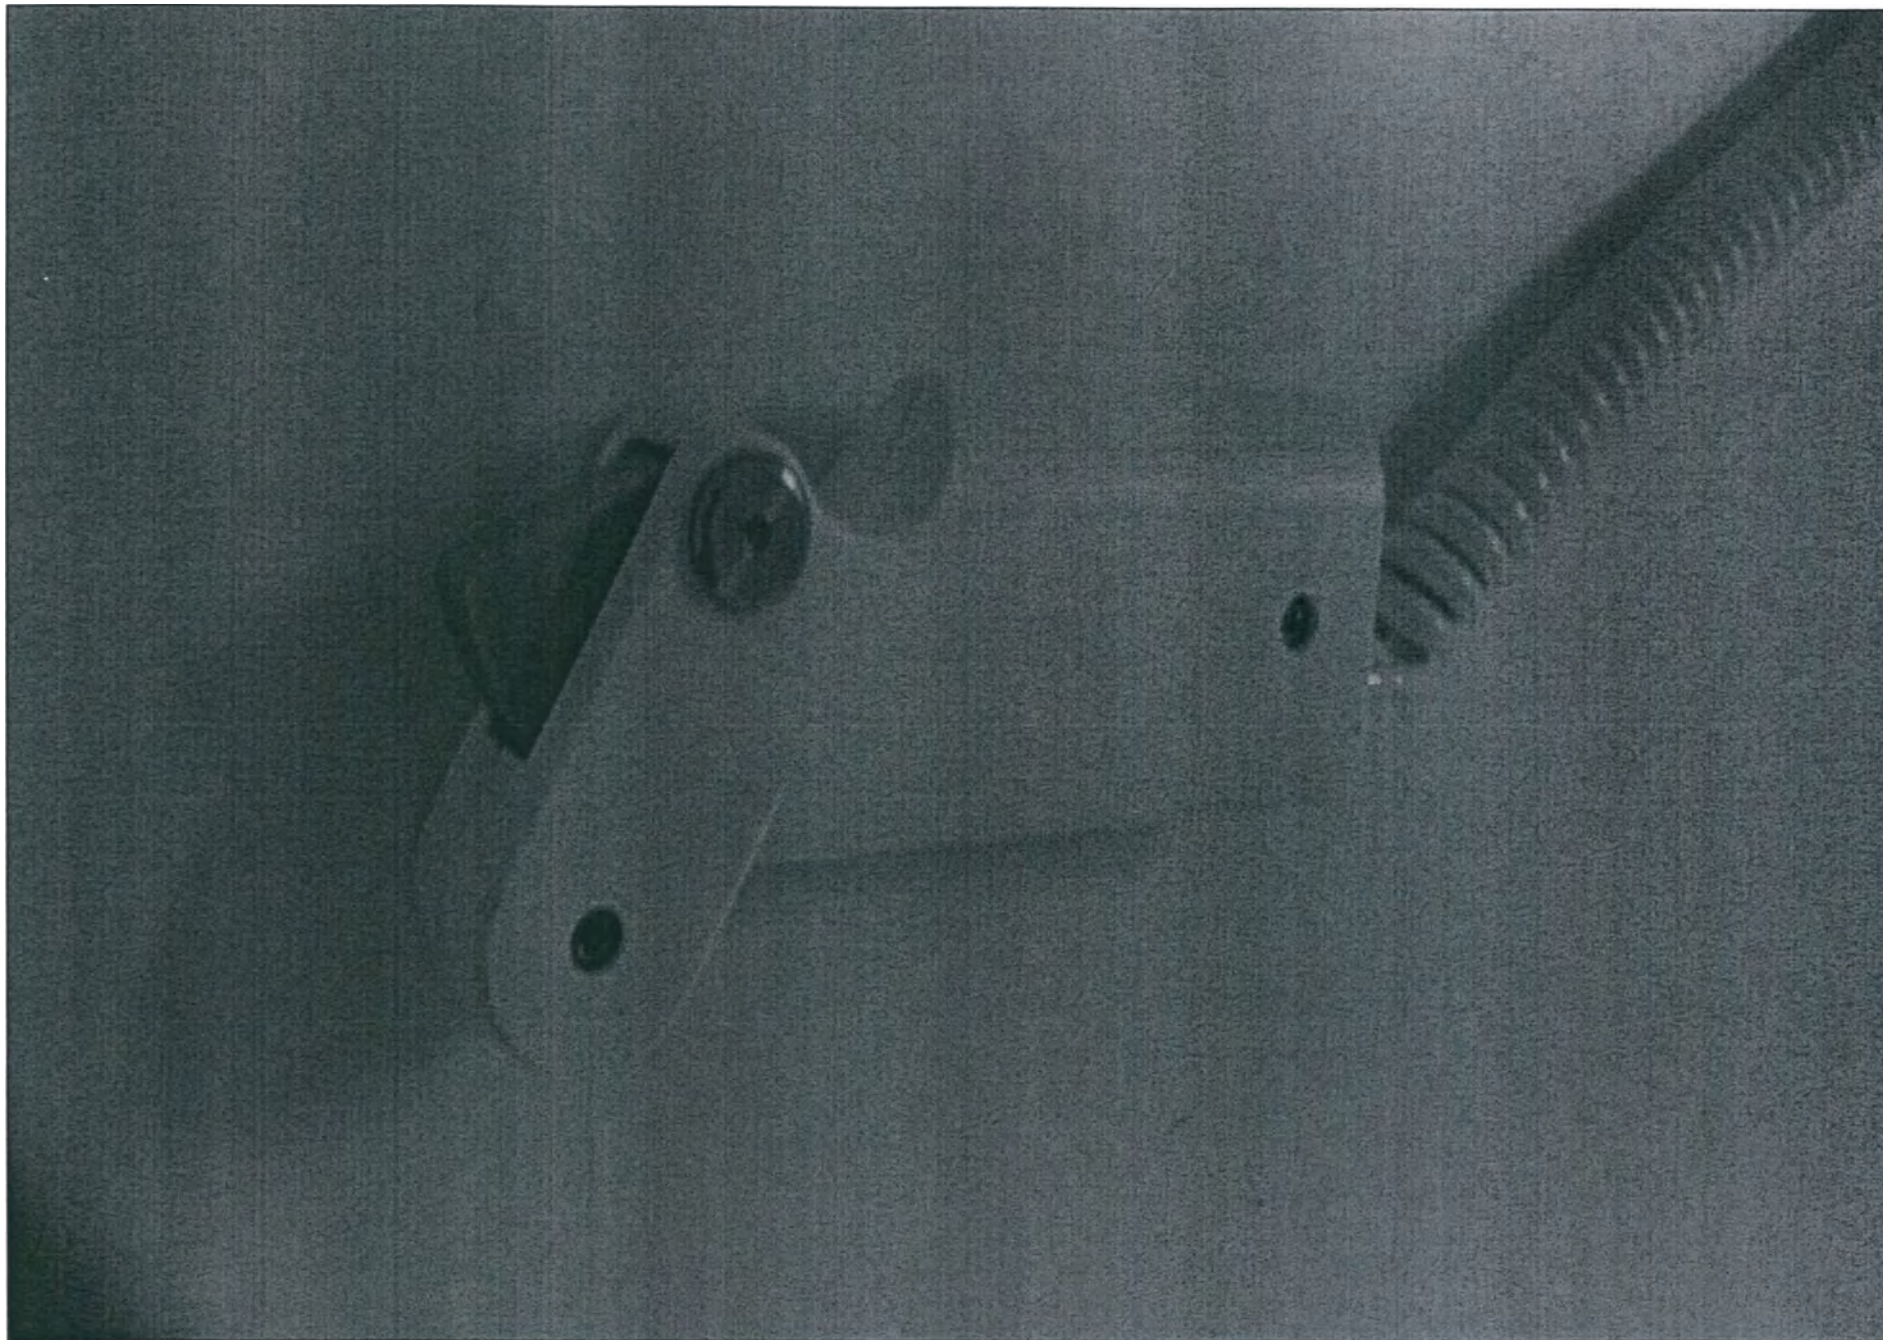


13. Регулятор скорости.




14. Ручной переключатель экспозиции.

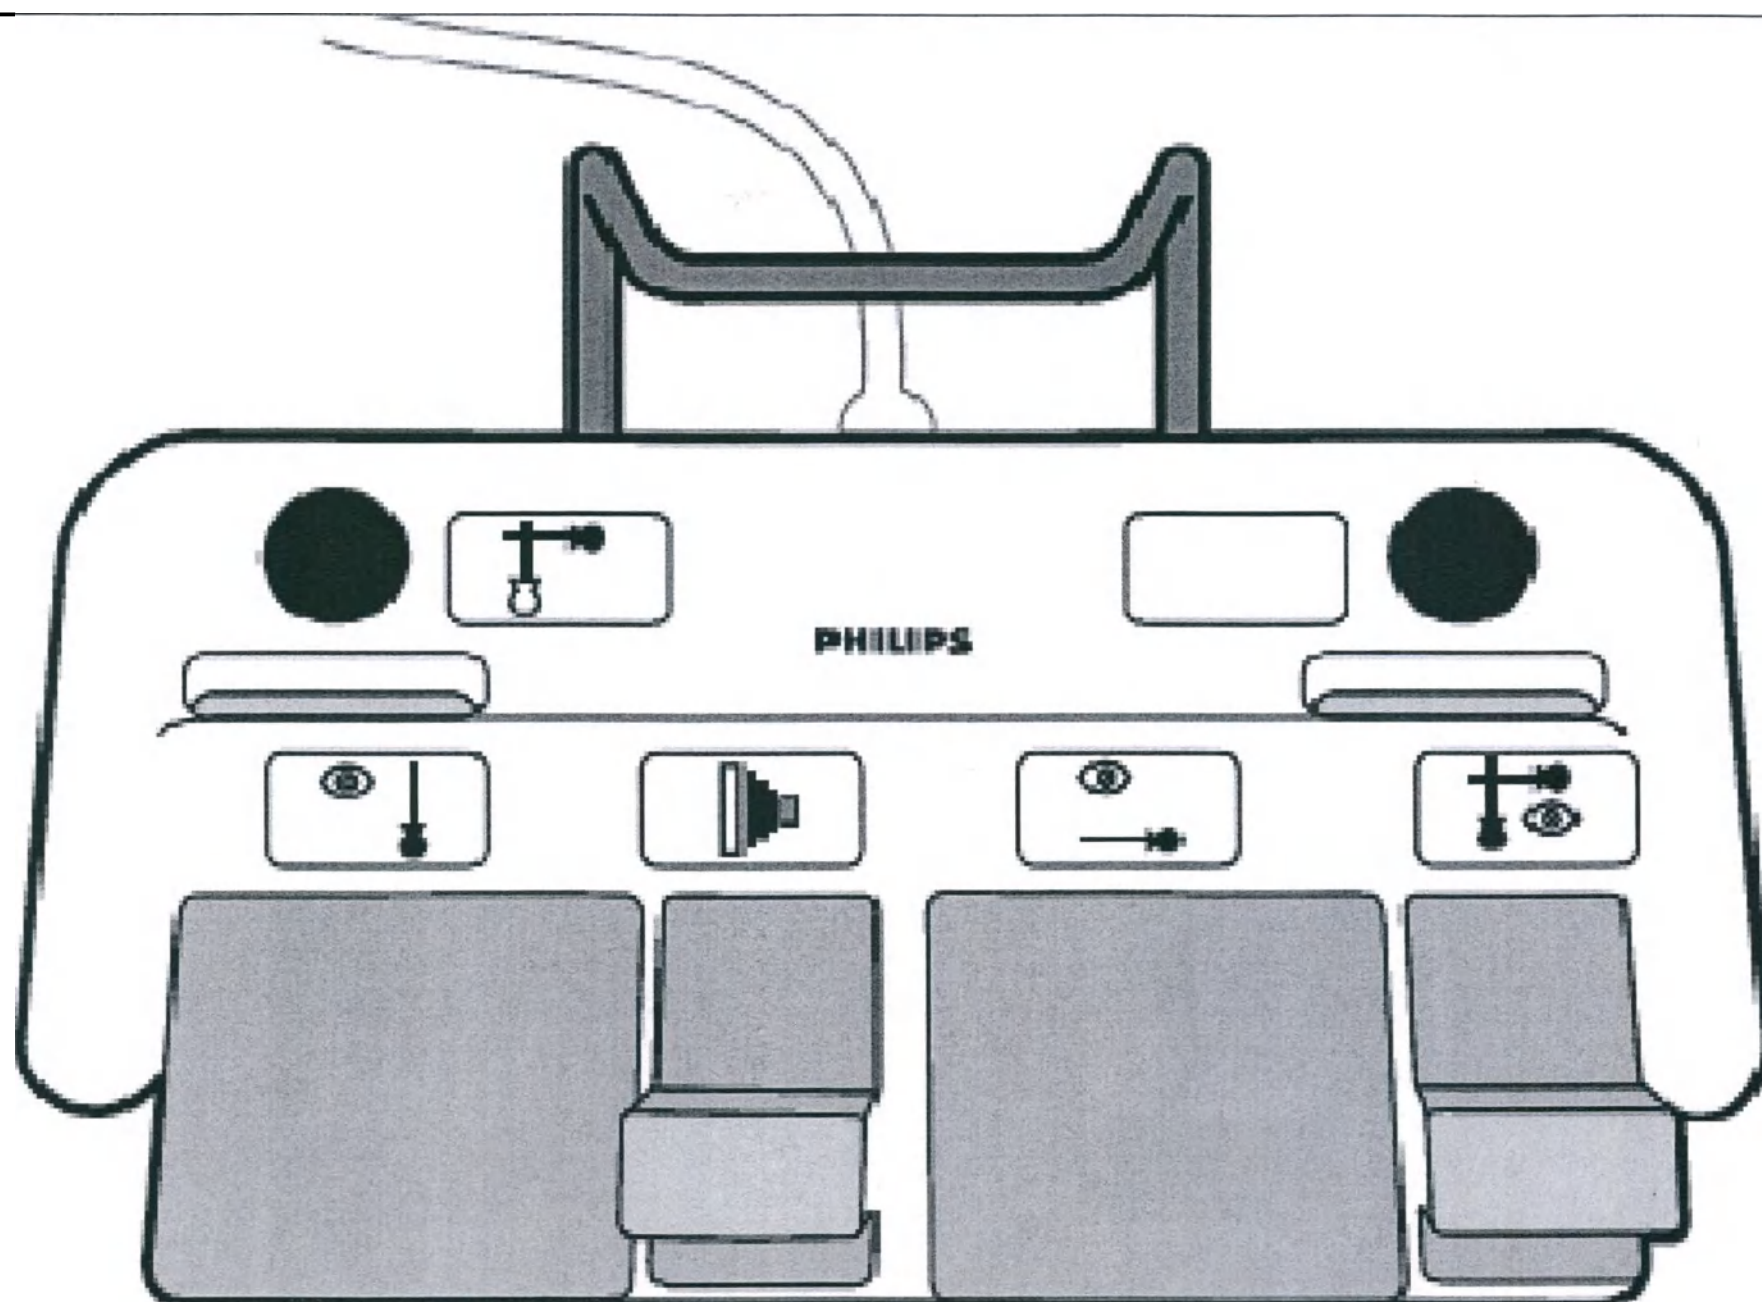


15. Ножной переключатель, не более 2 шт.

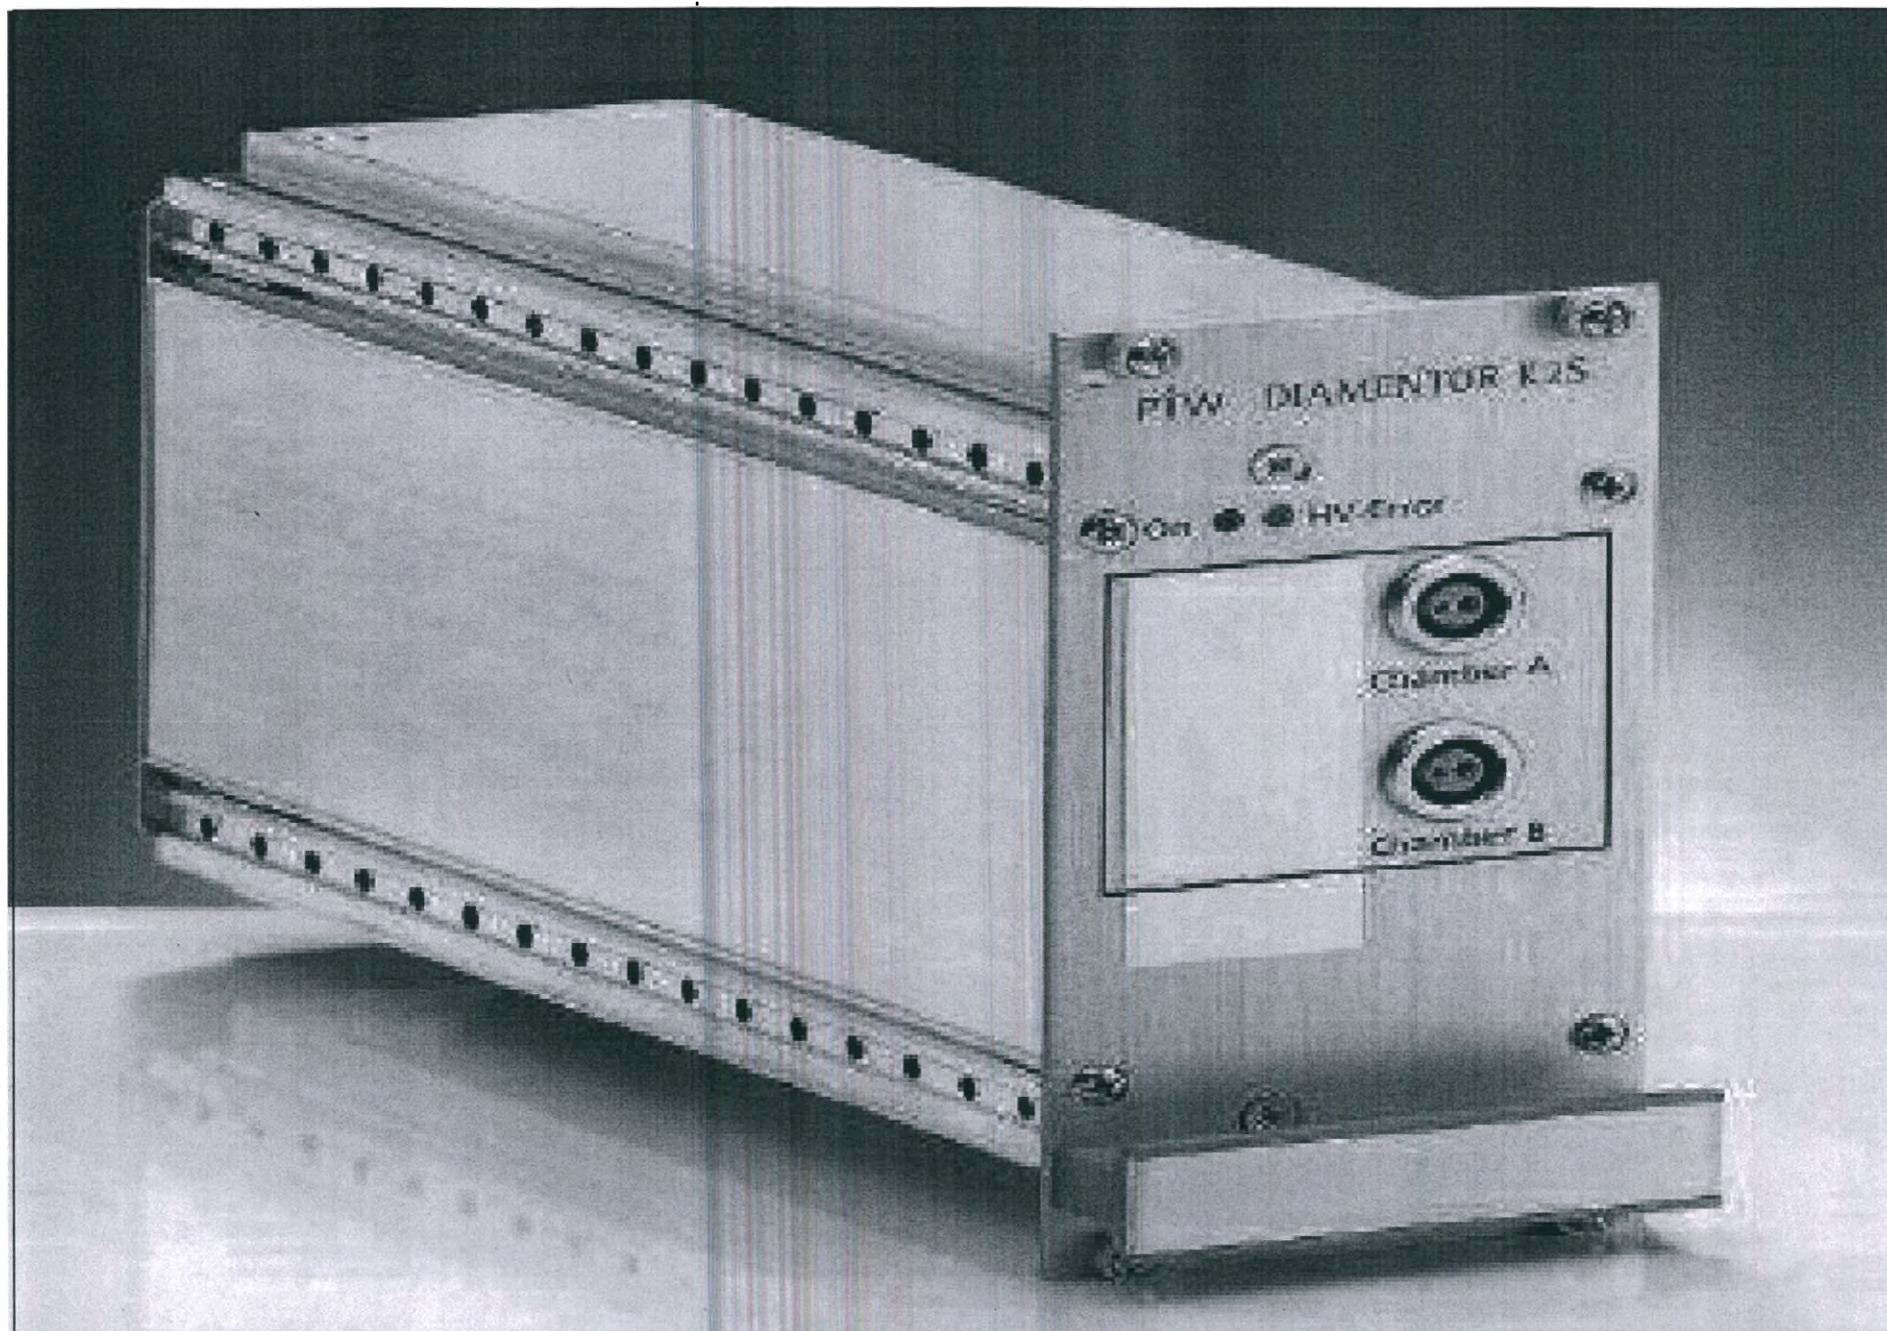


16.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR KIS T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

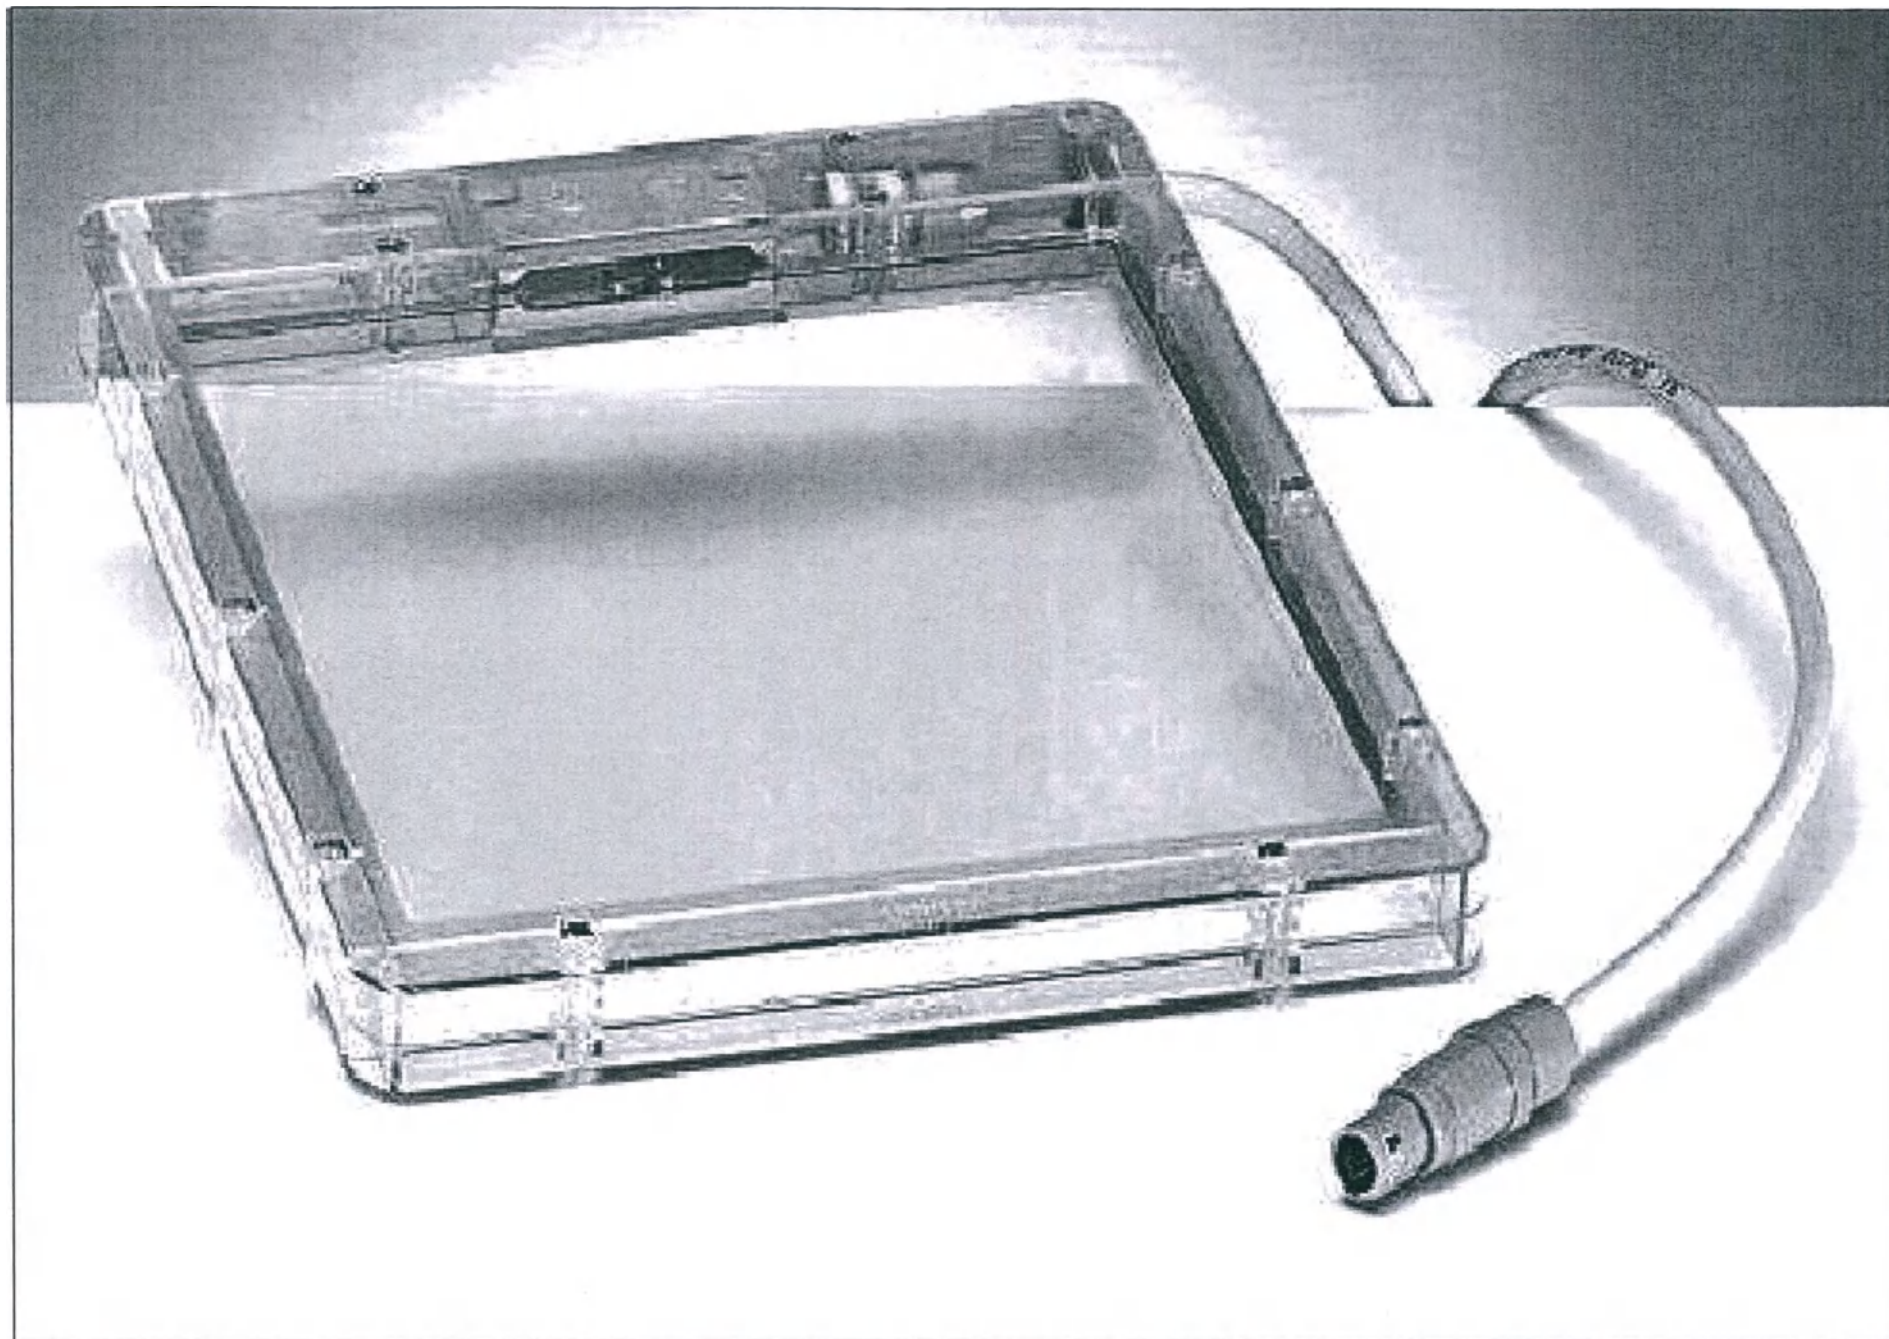


16.6. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

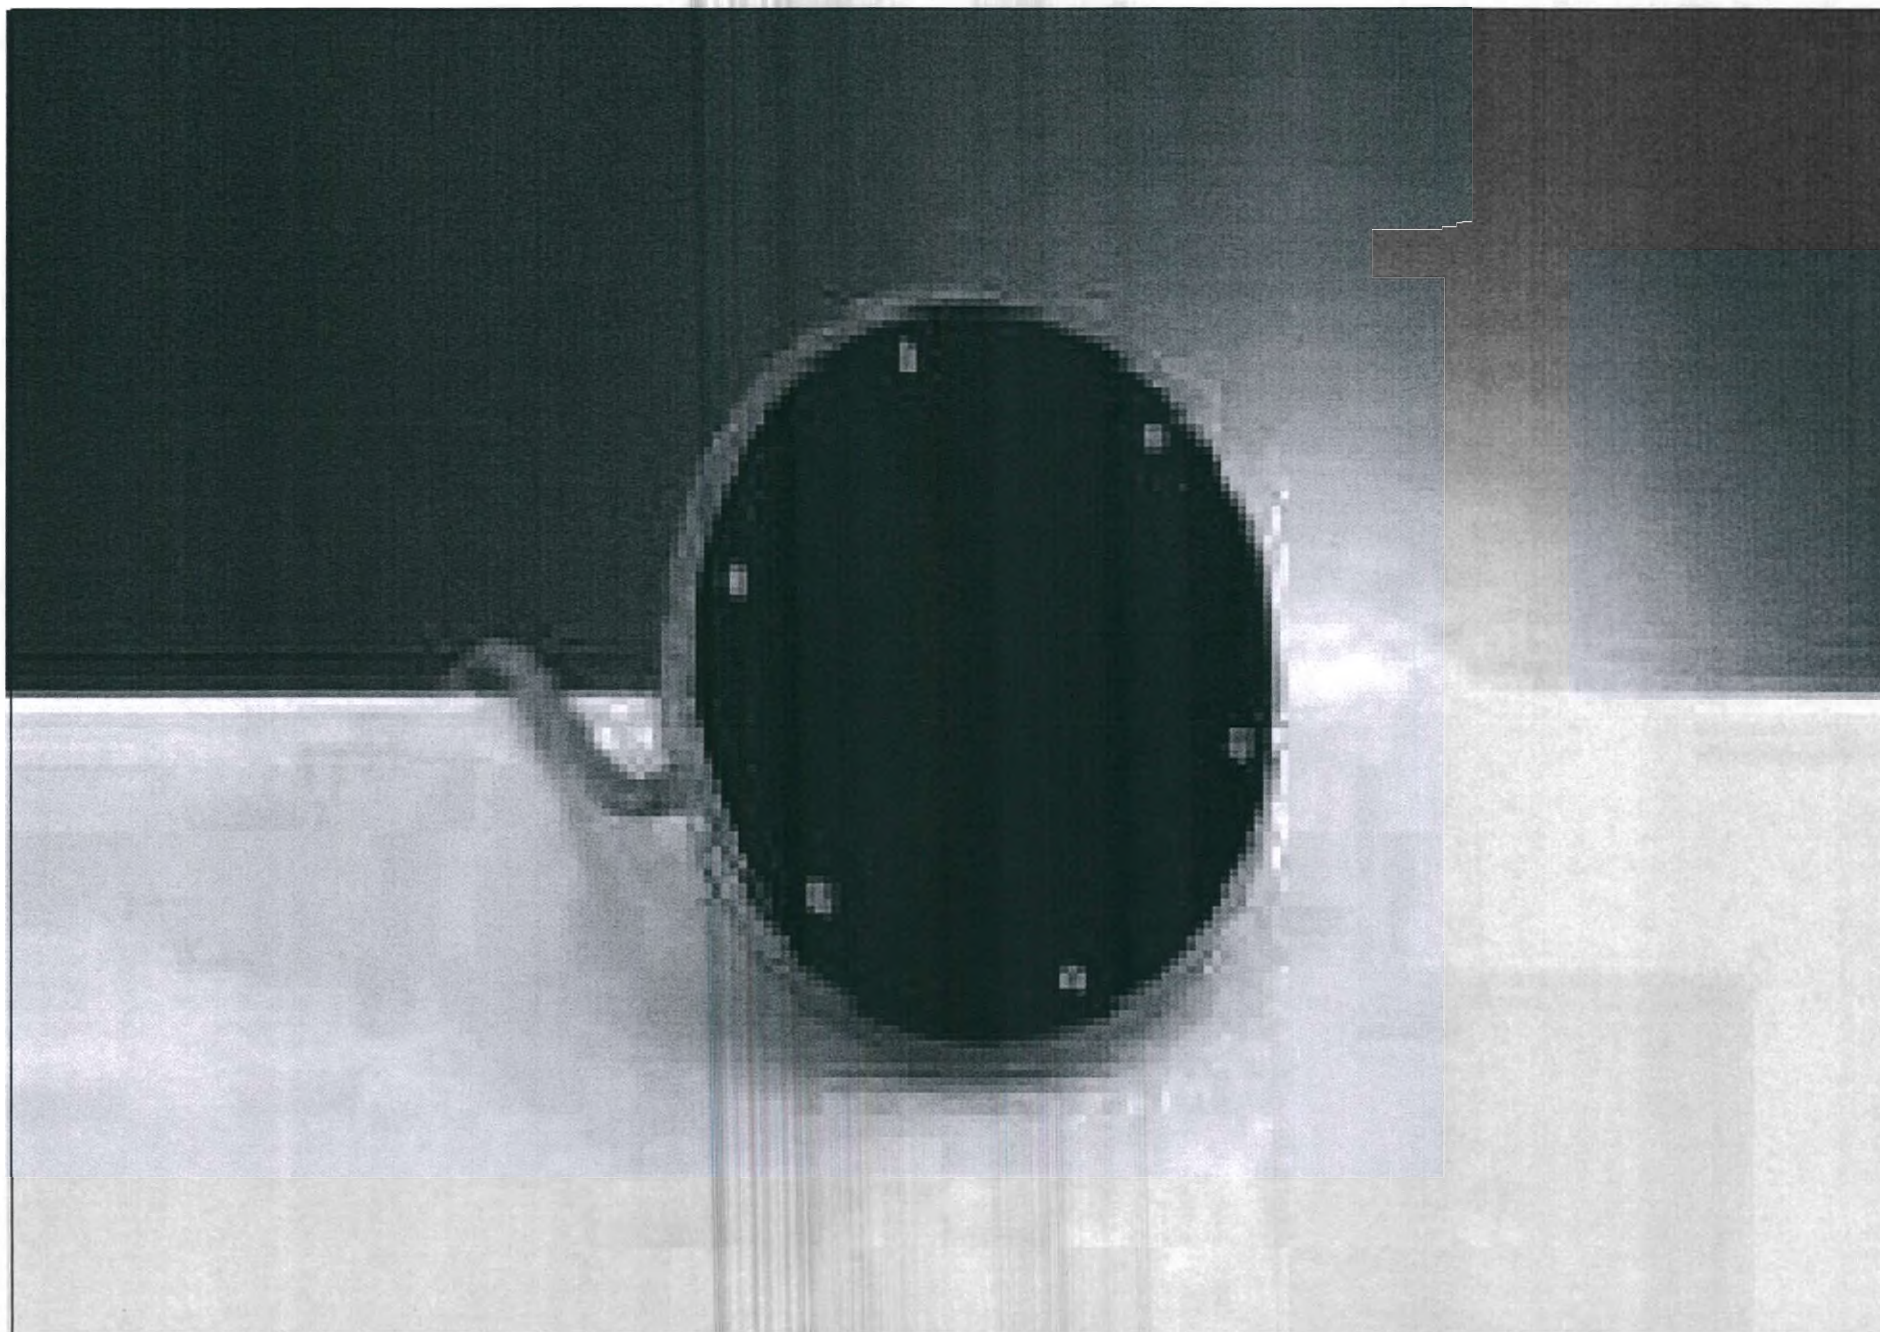


16.в. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДПК-1* или *ДПК-1М*.

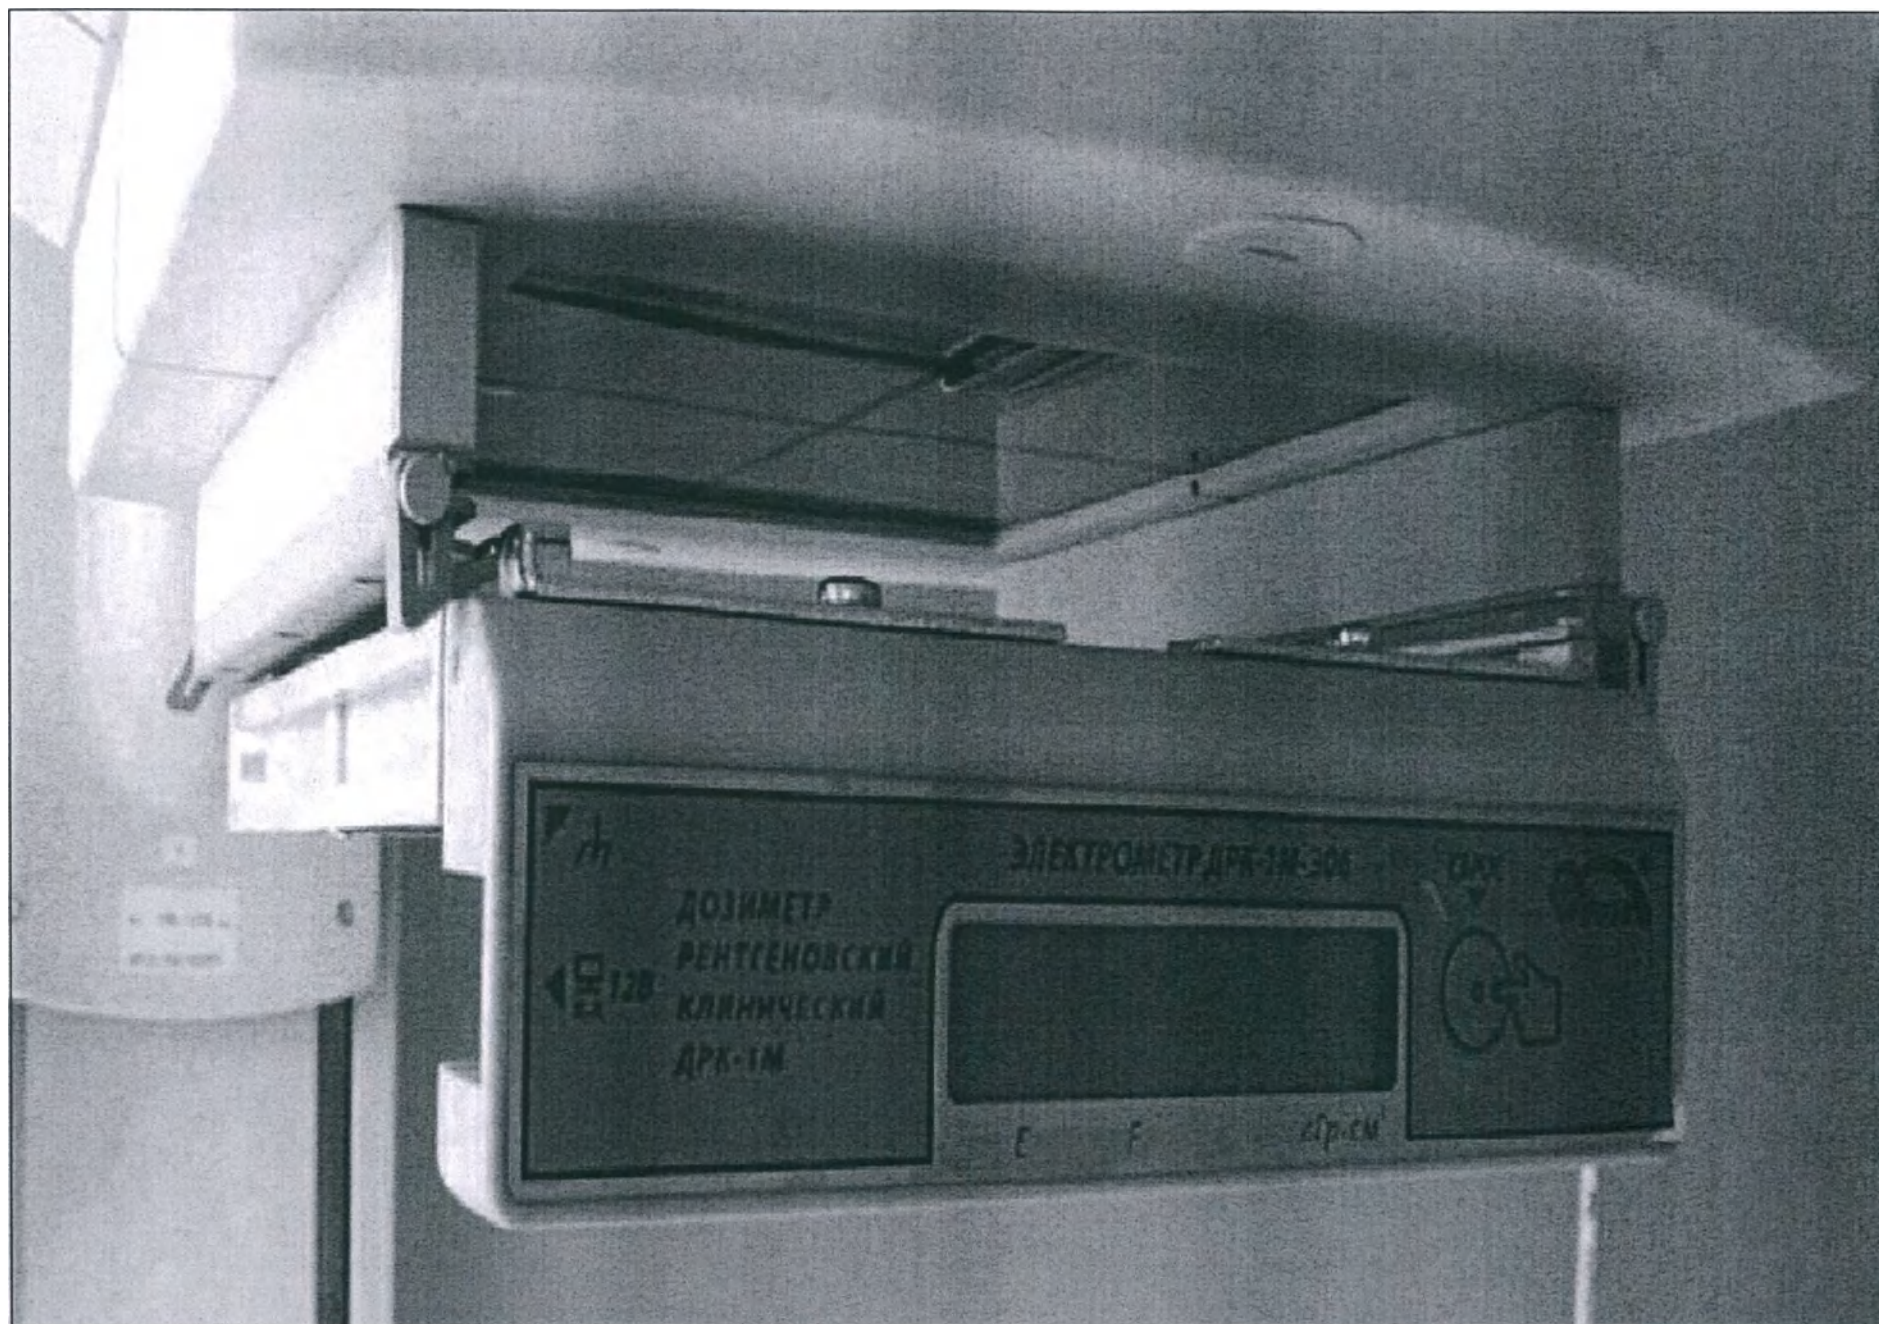


16.г. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

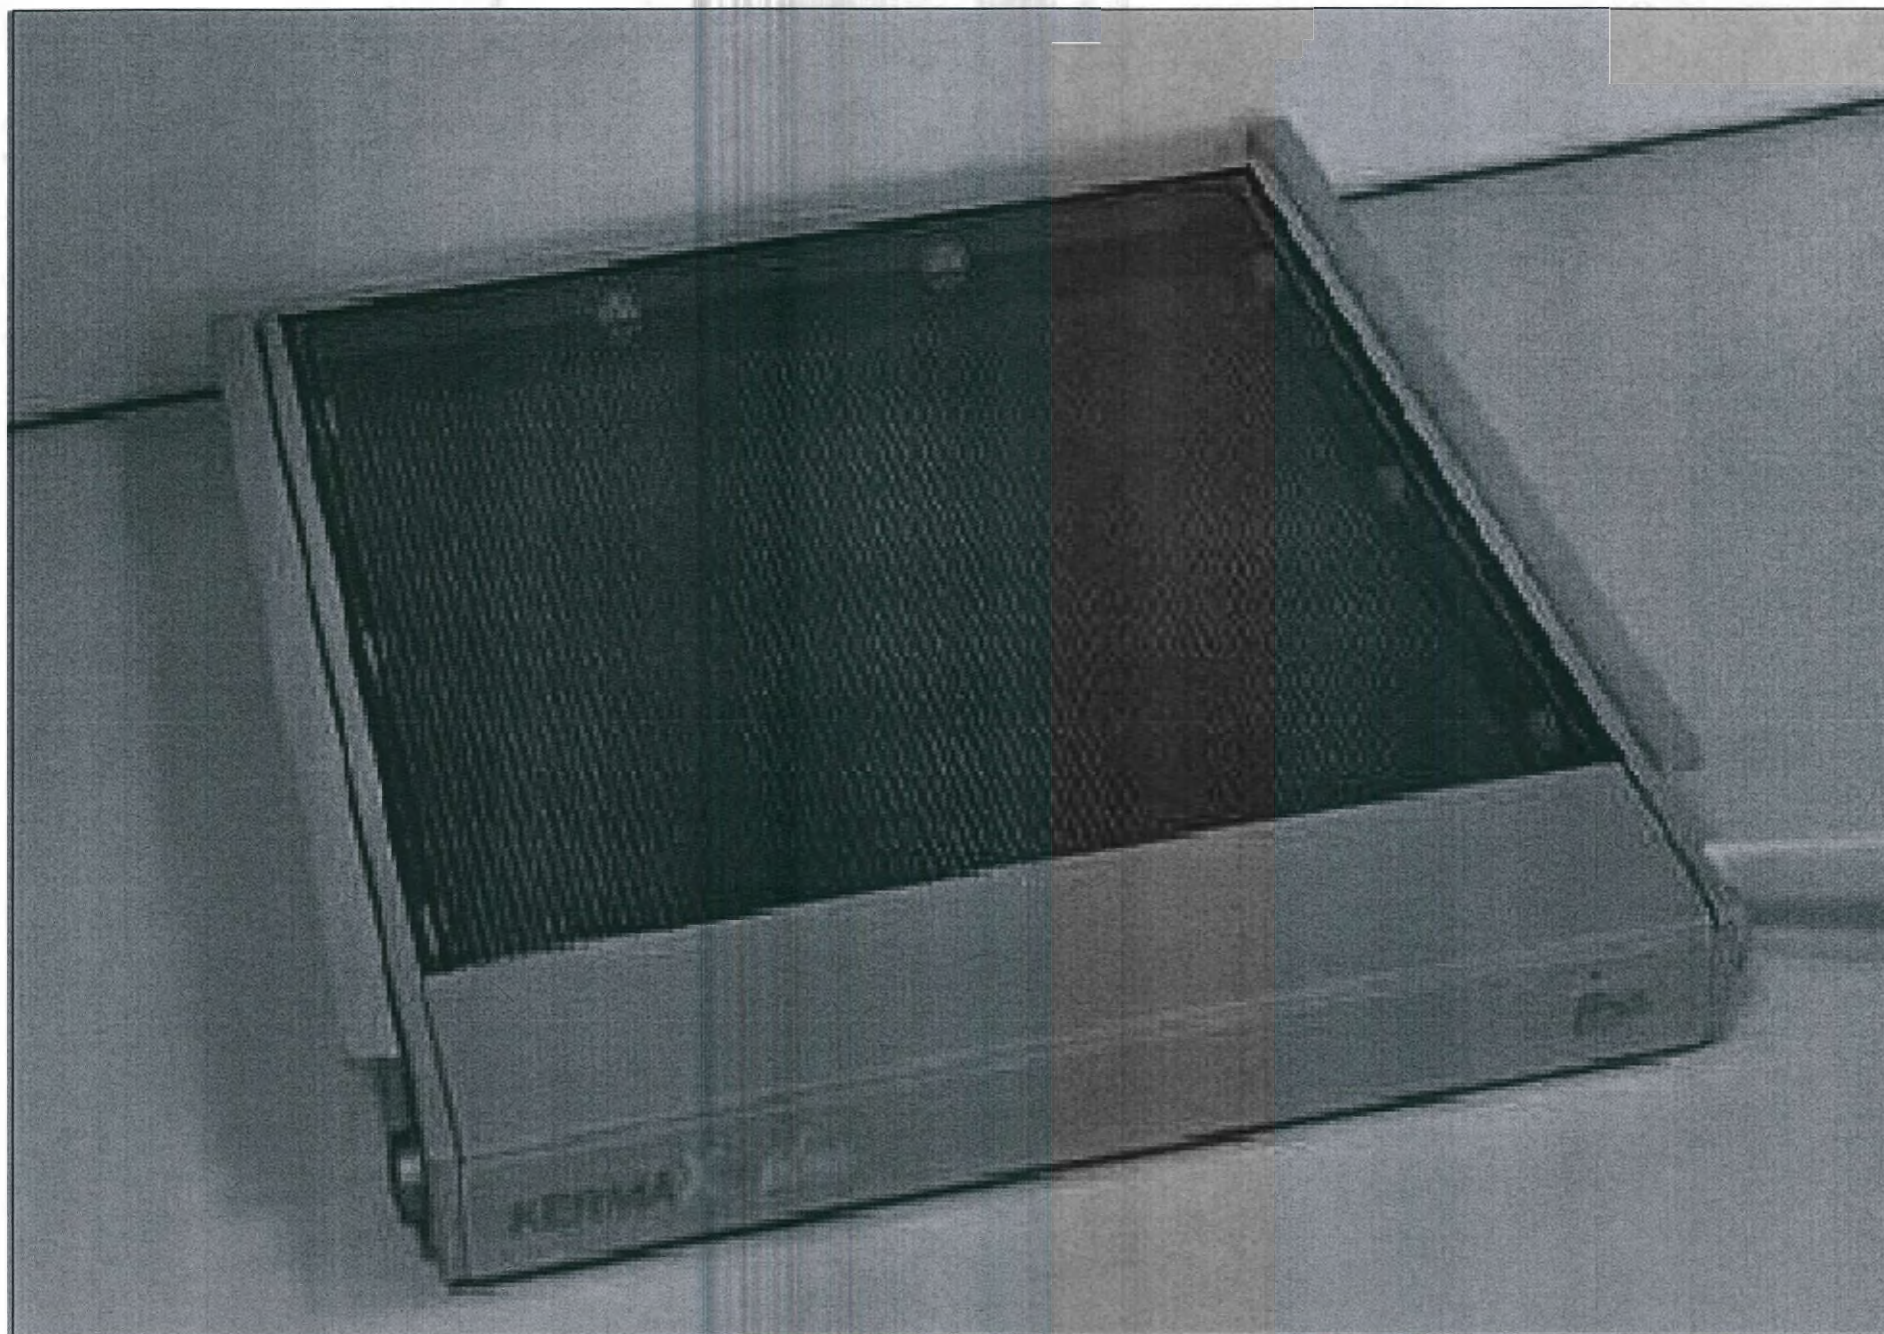


17. Измеритель производства дозы на площадь Kertax plus 120-132.

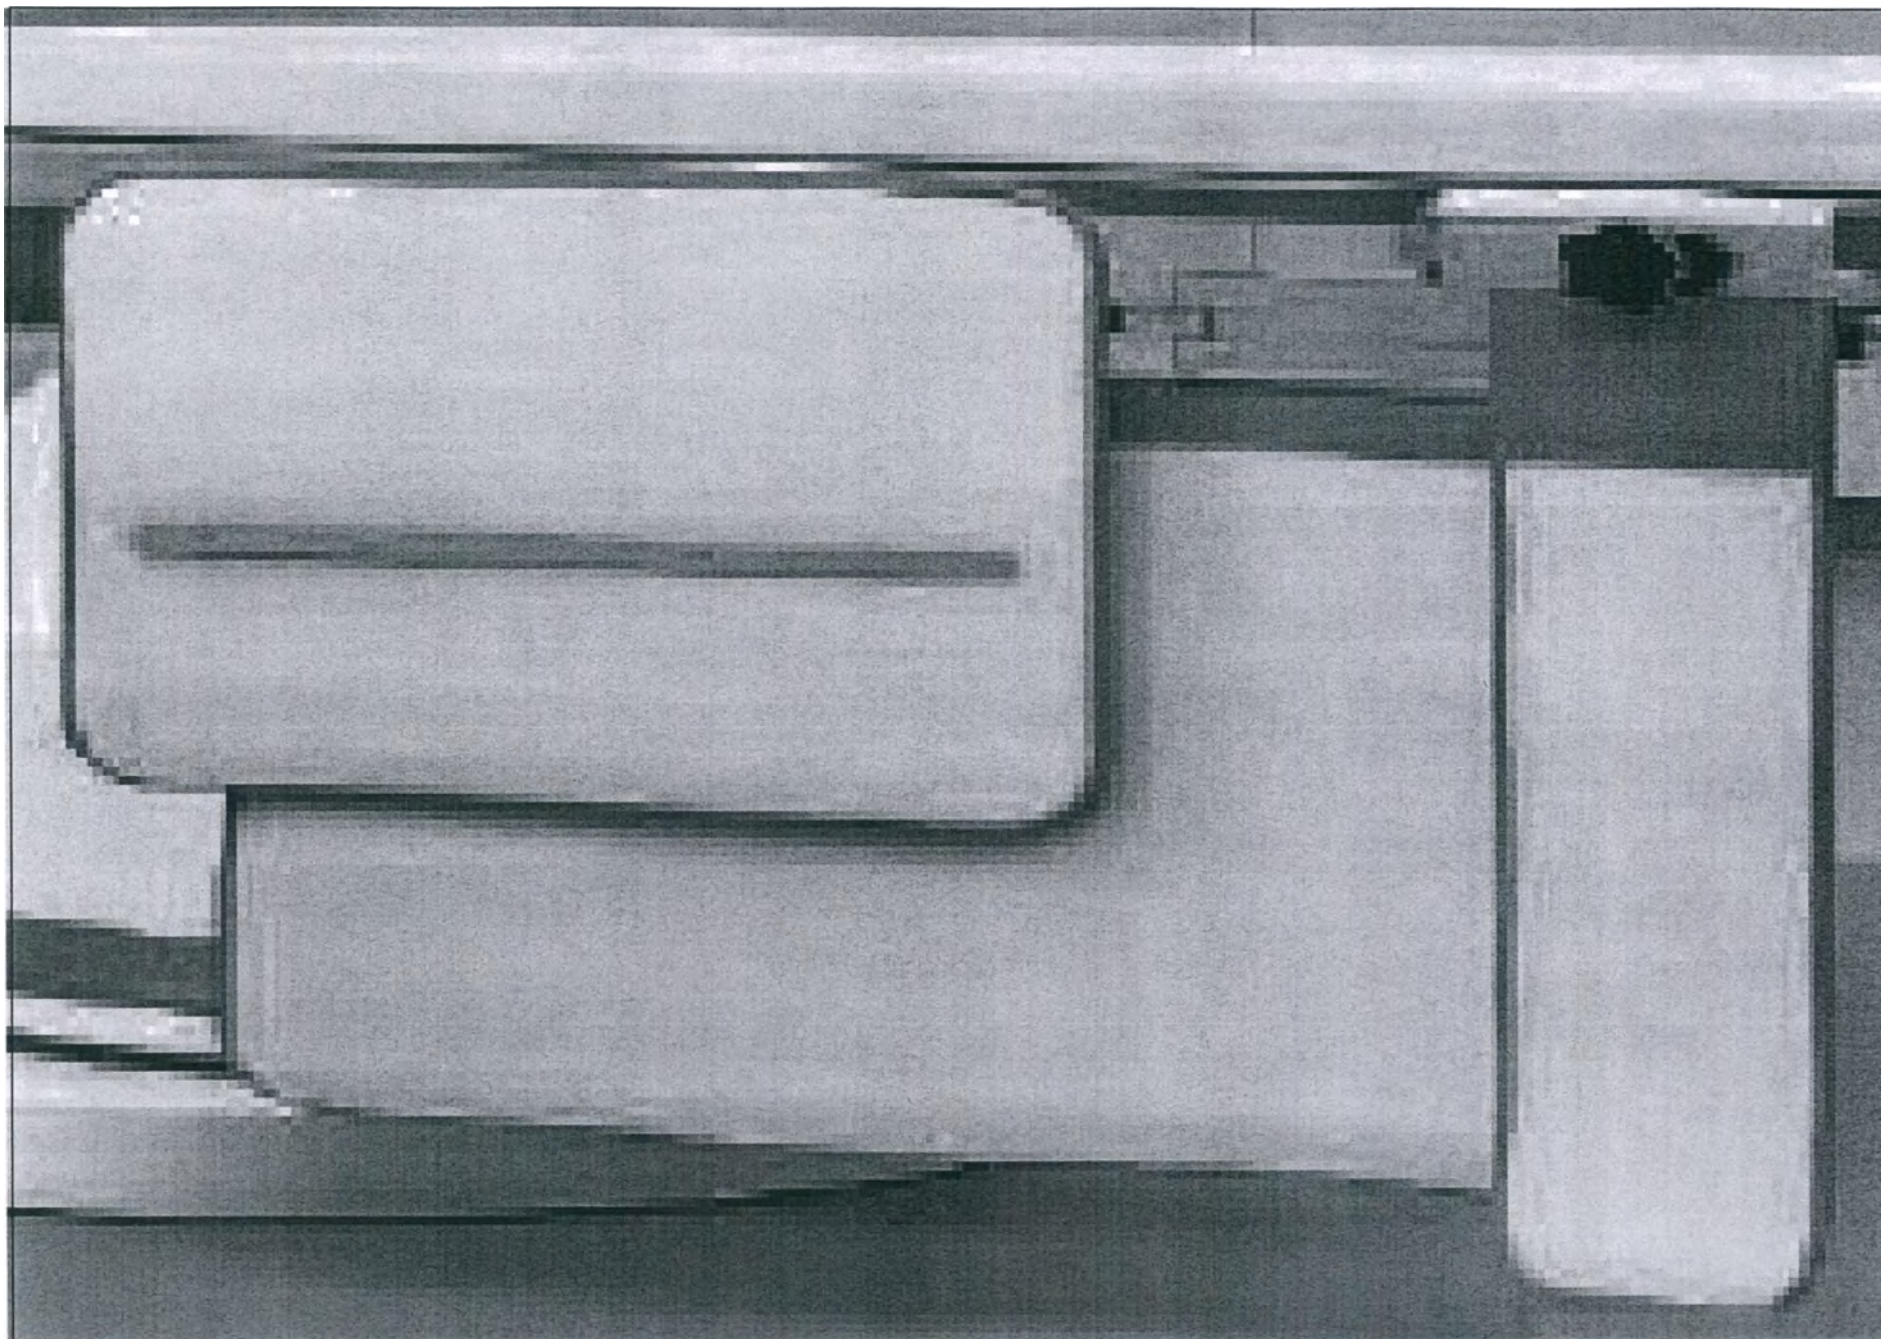


18. Экран радиационной защиты настольный

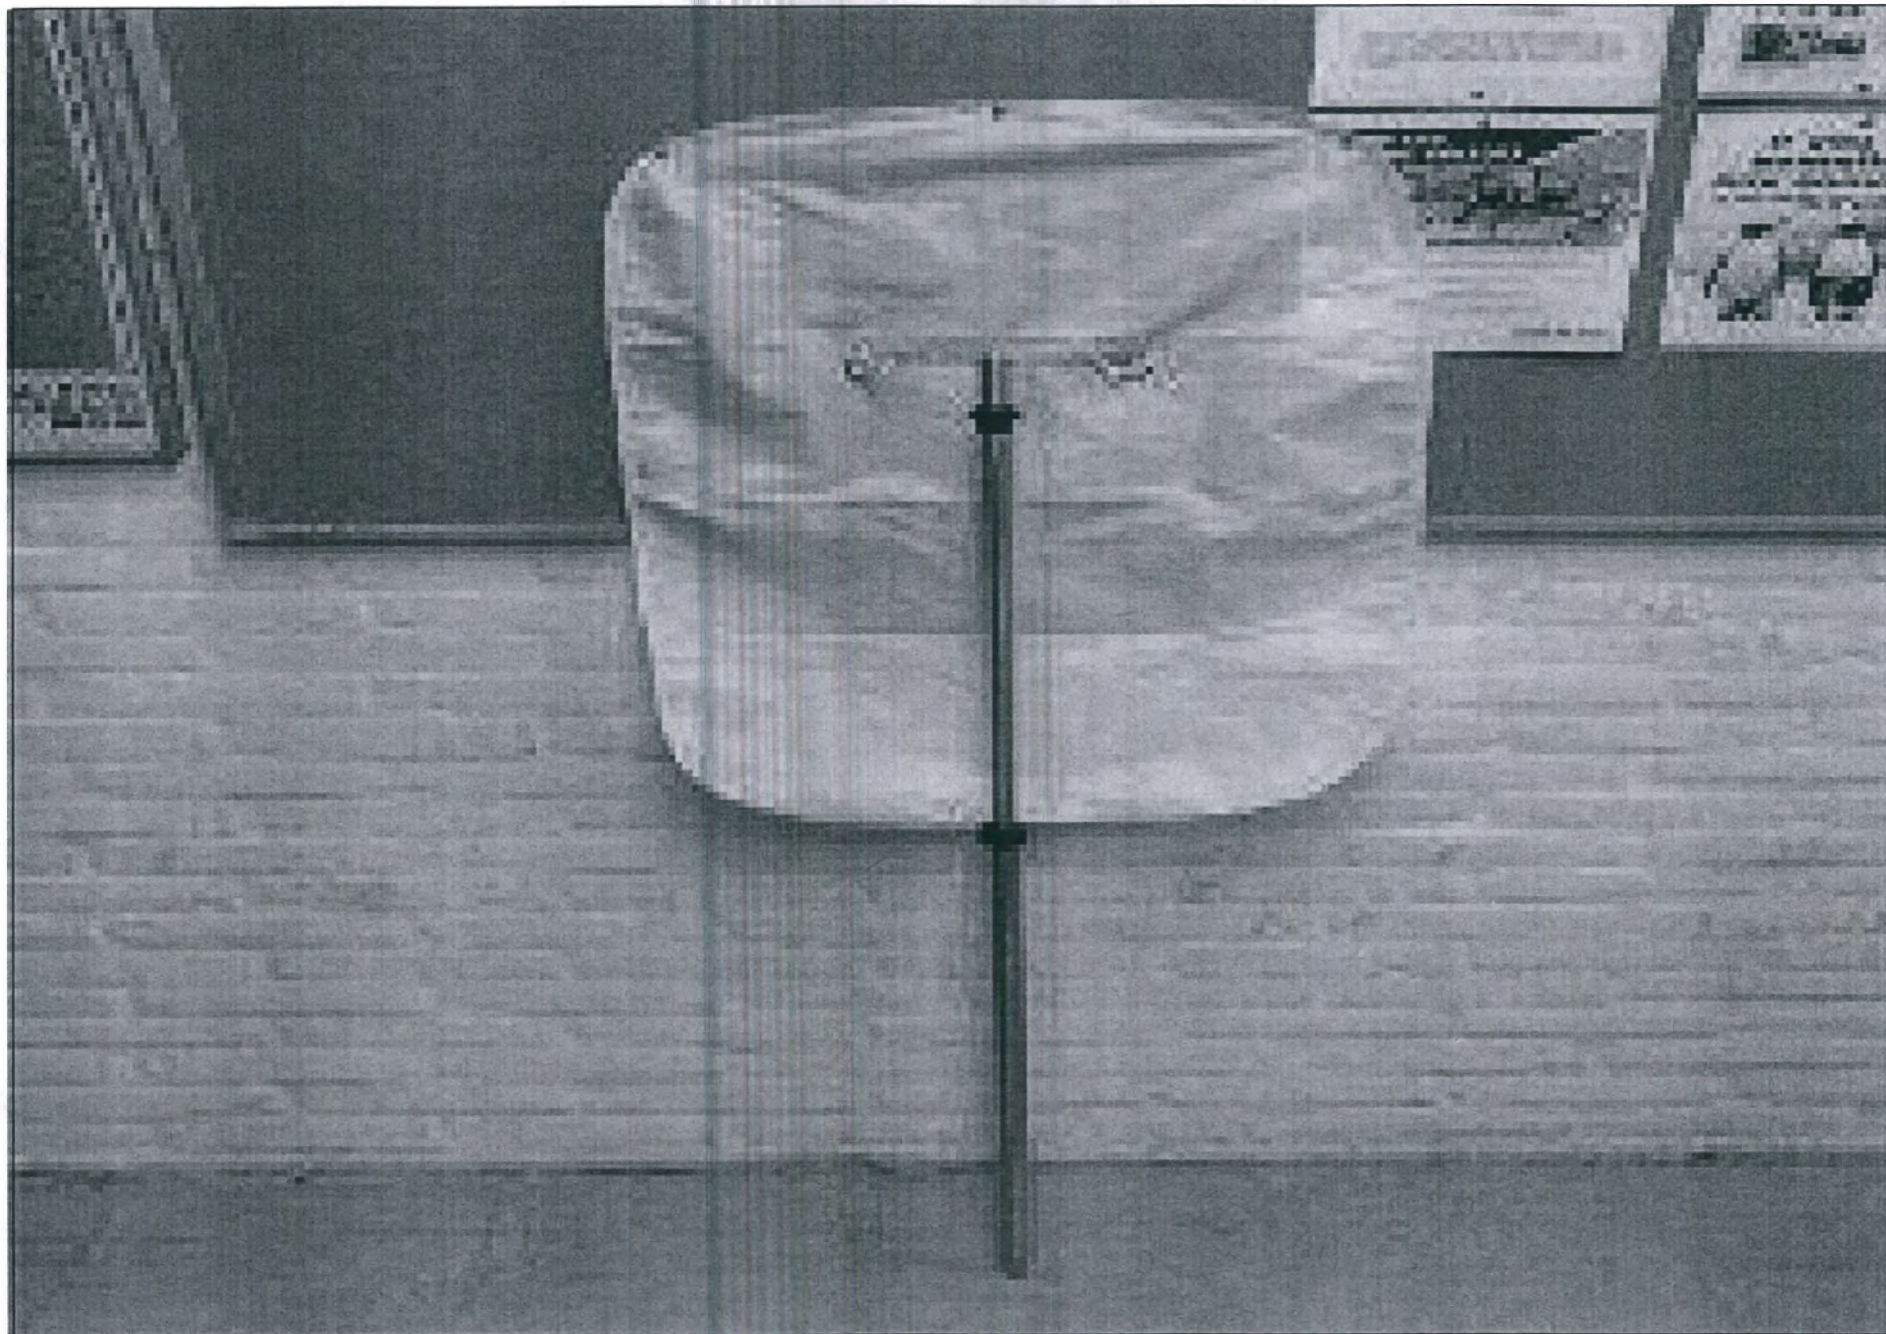

19. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

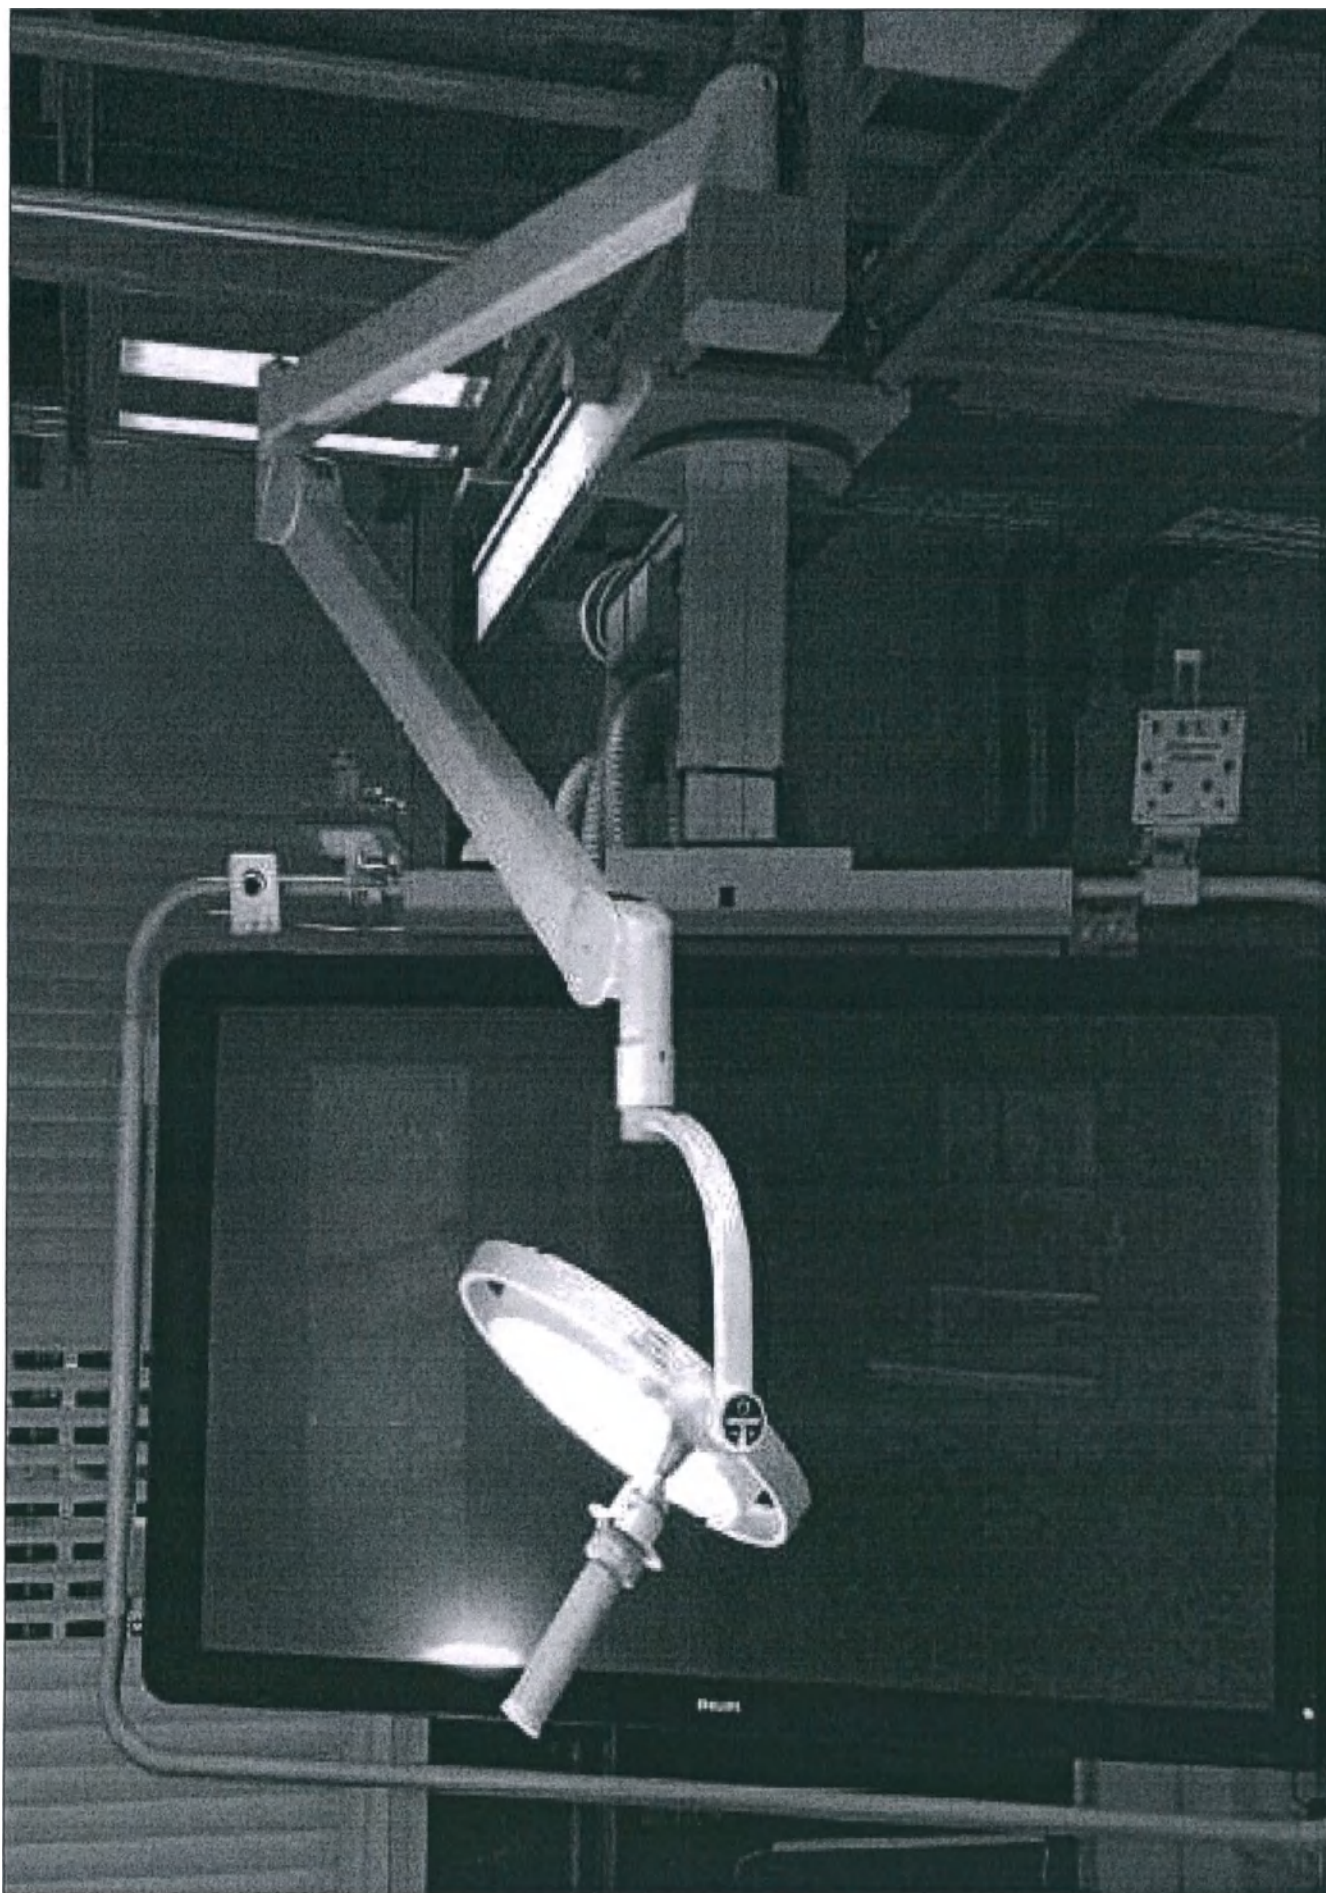

20. Лампа для осмотра

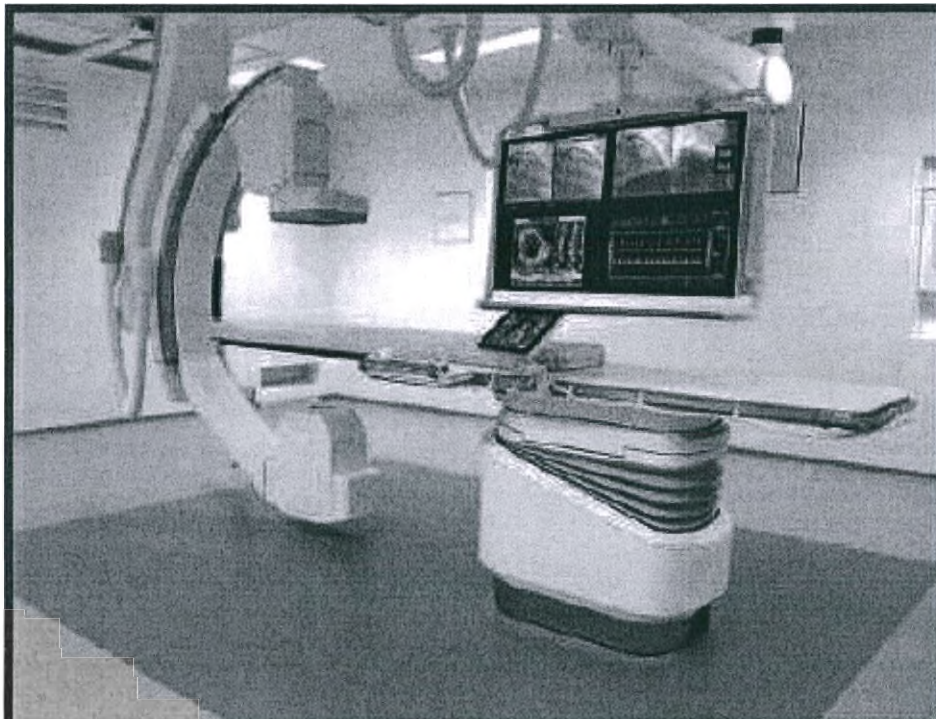

Руководство по
эксплуатации

Русский

4522 203 52651


Azurion

Версия 1.2


PHILIPS

22. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 5 M12, в составе:

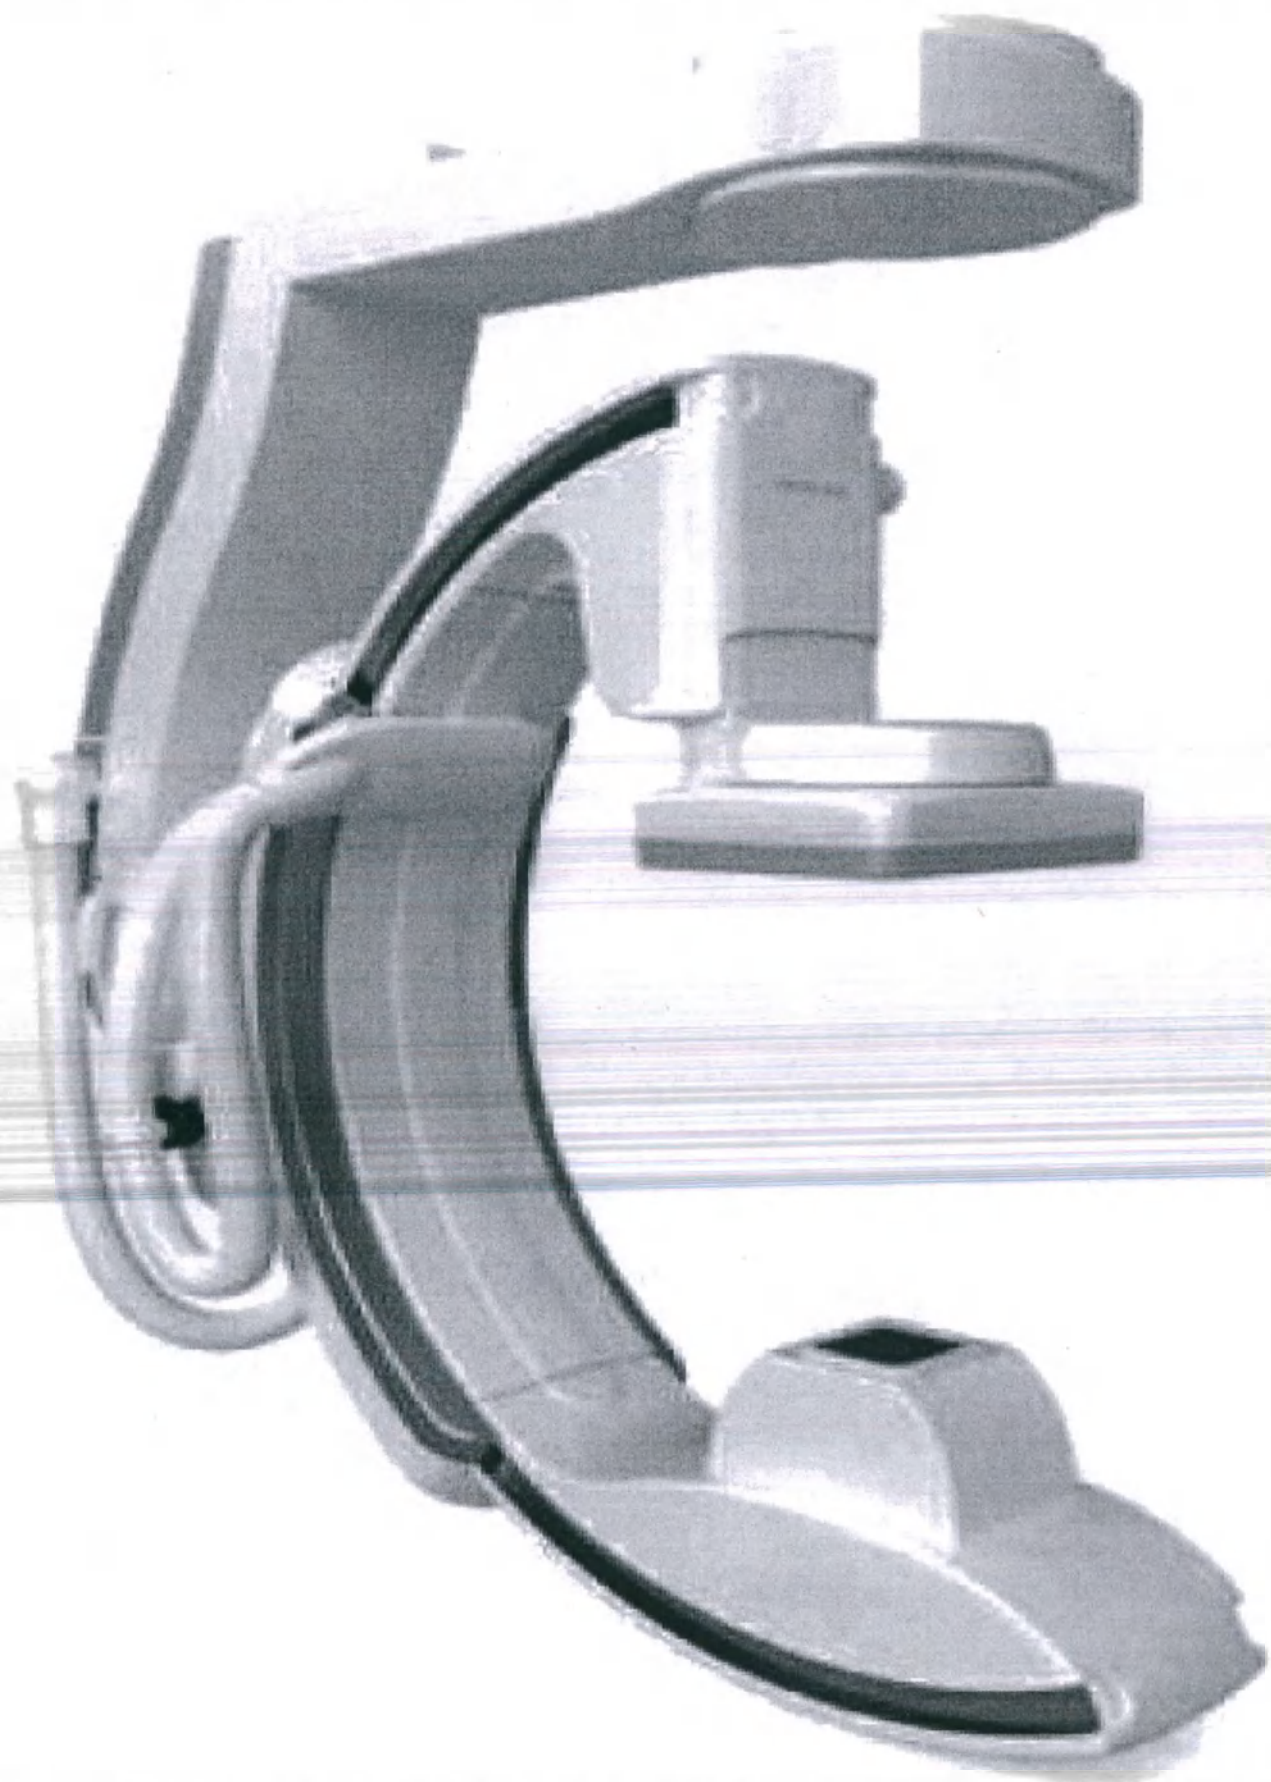


1. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C12.

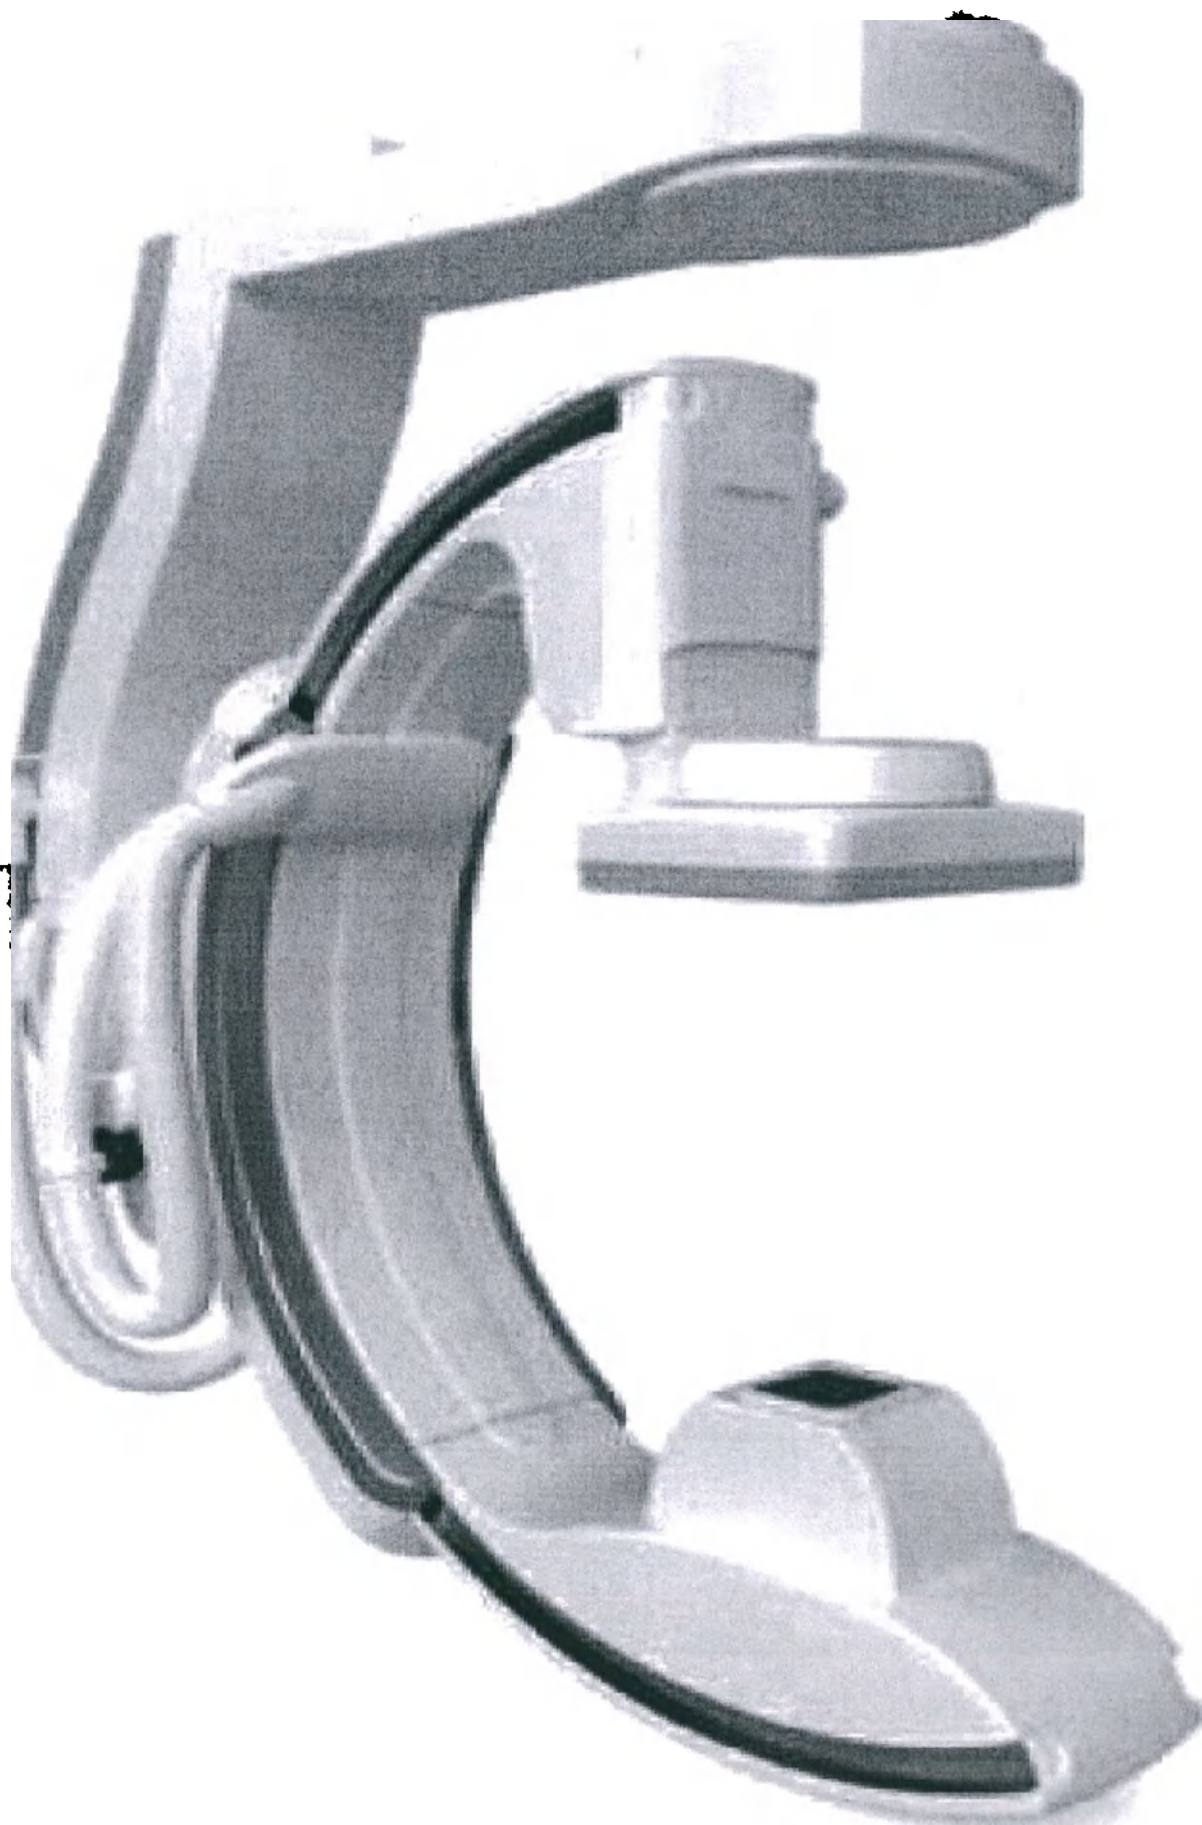


1.а. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

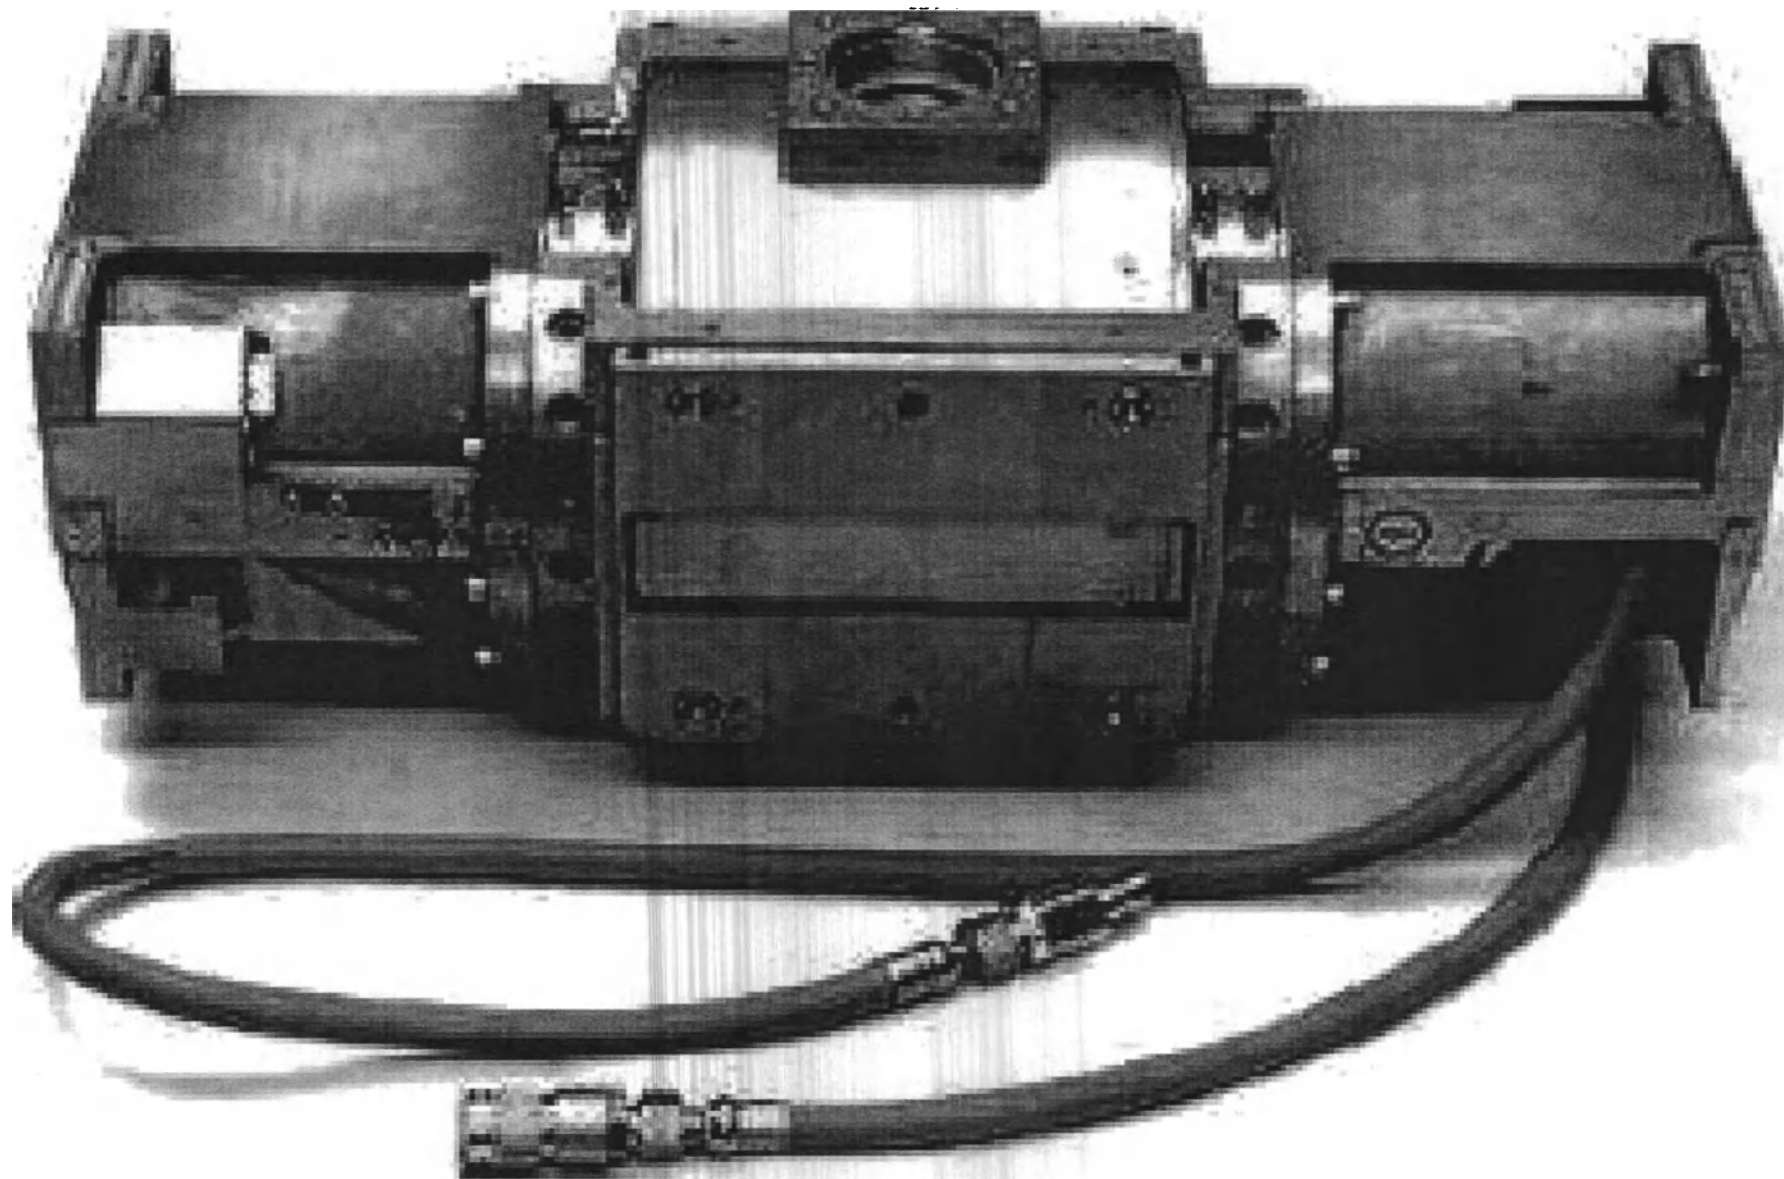


1.6. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

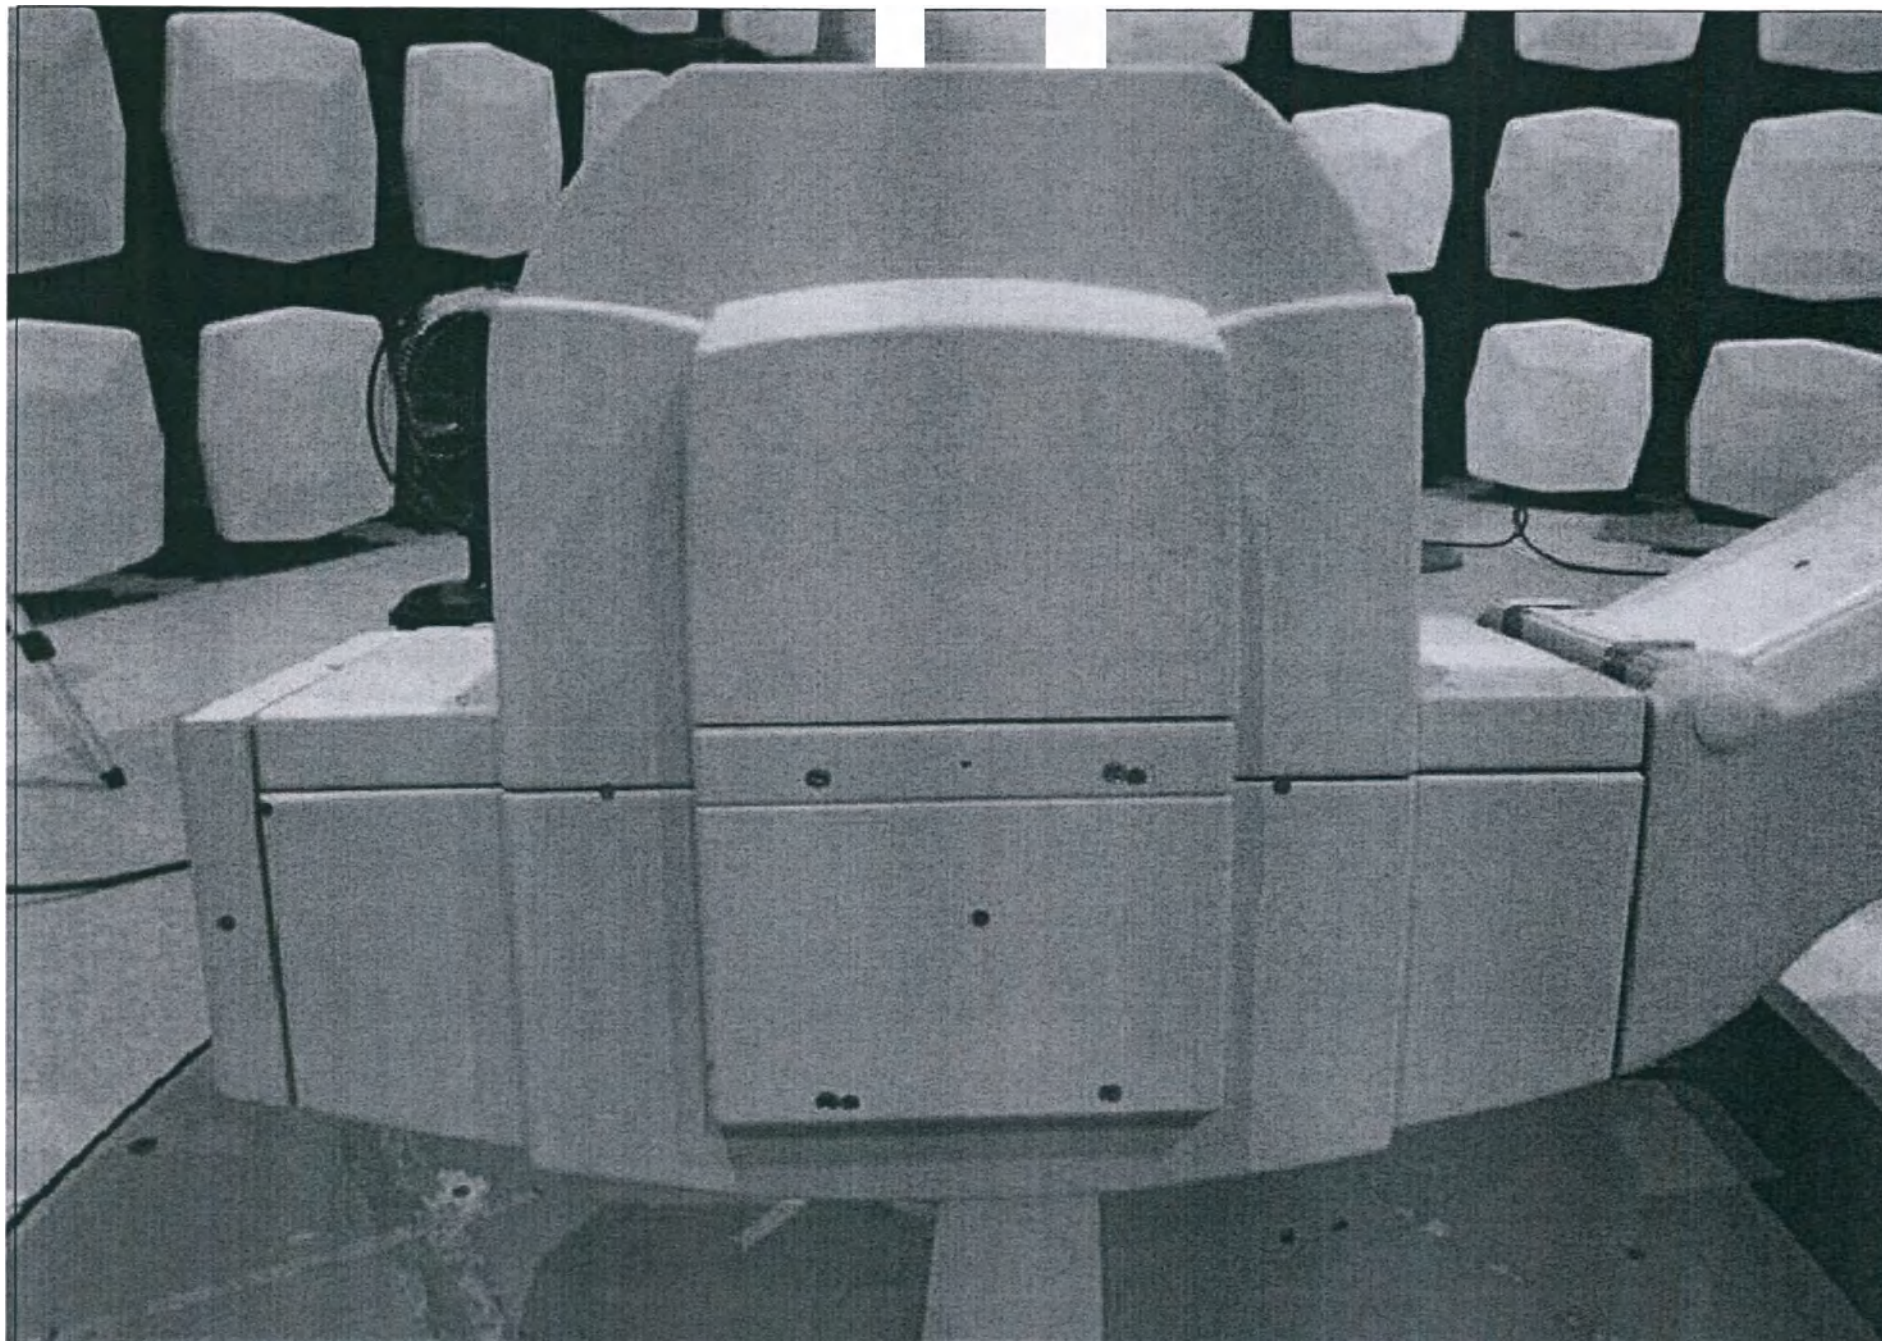


1.в. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

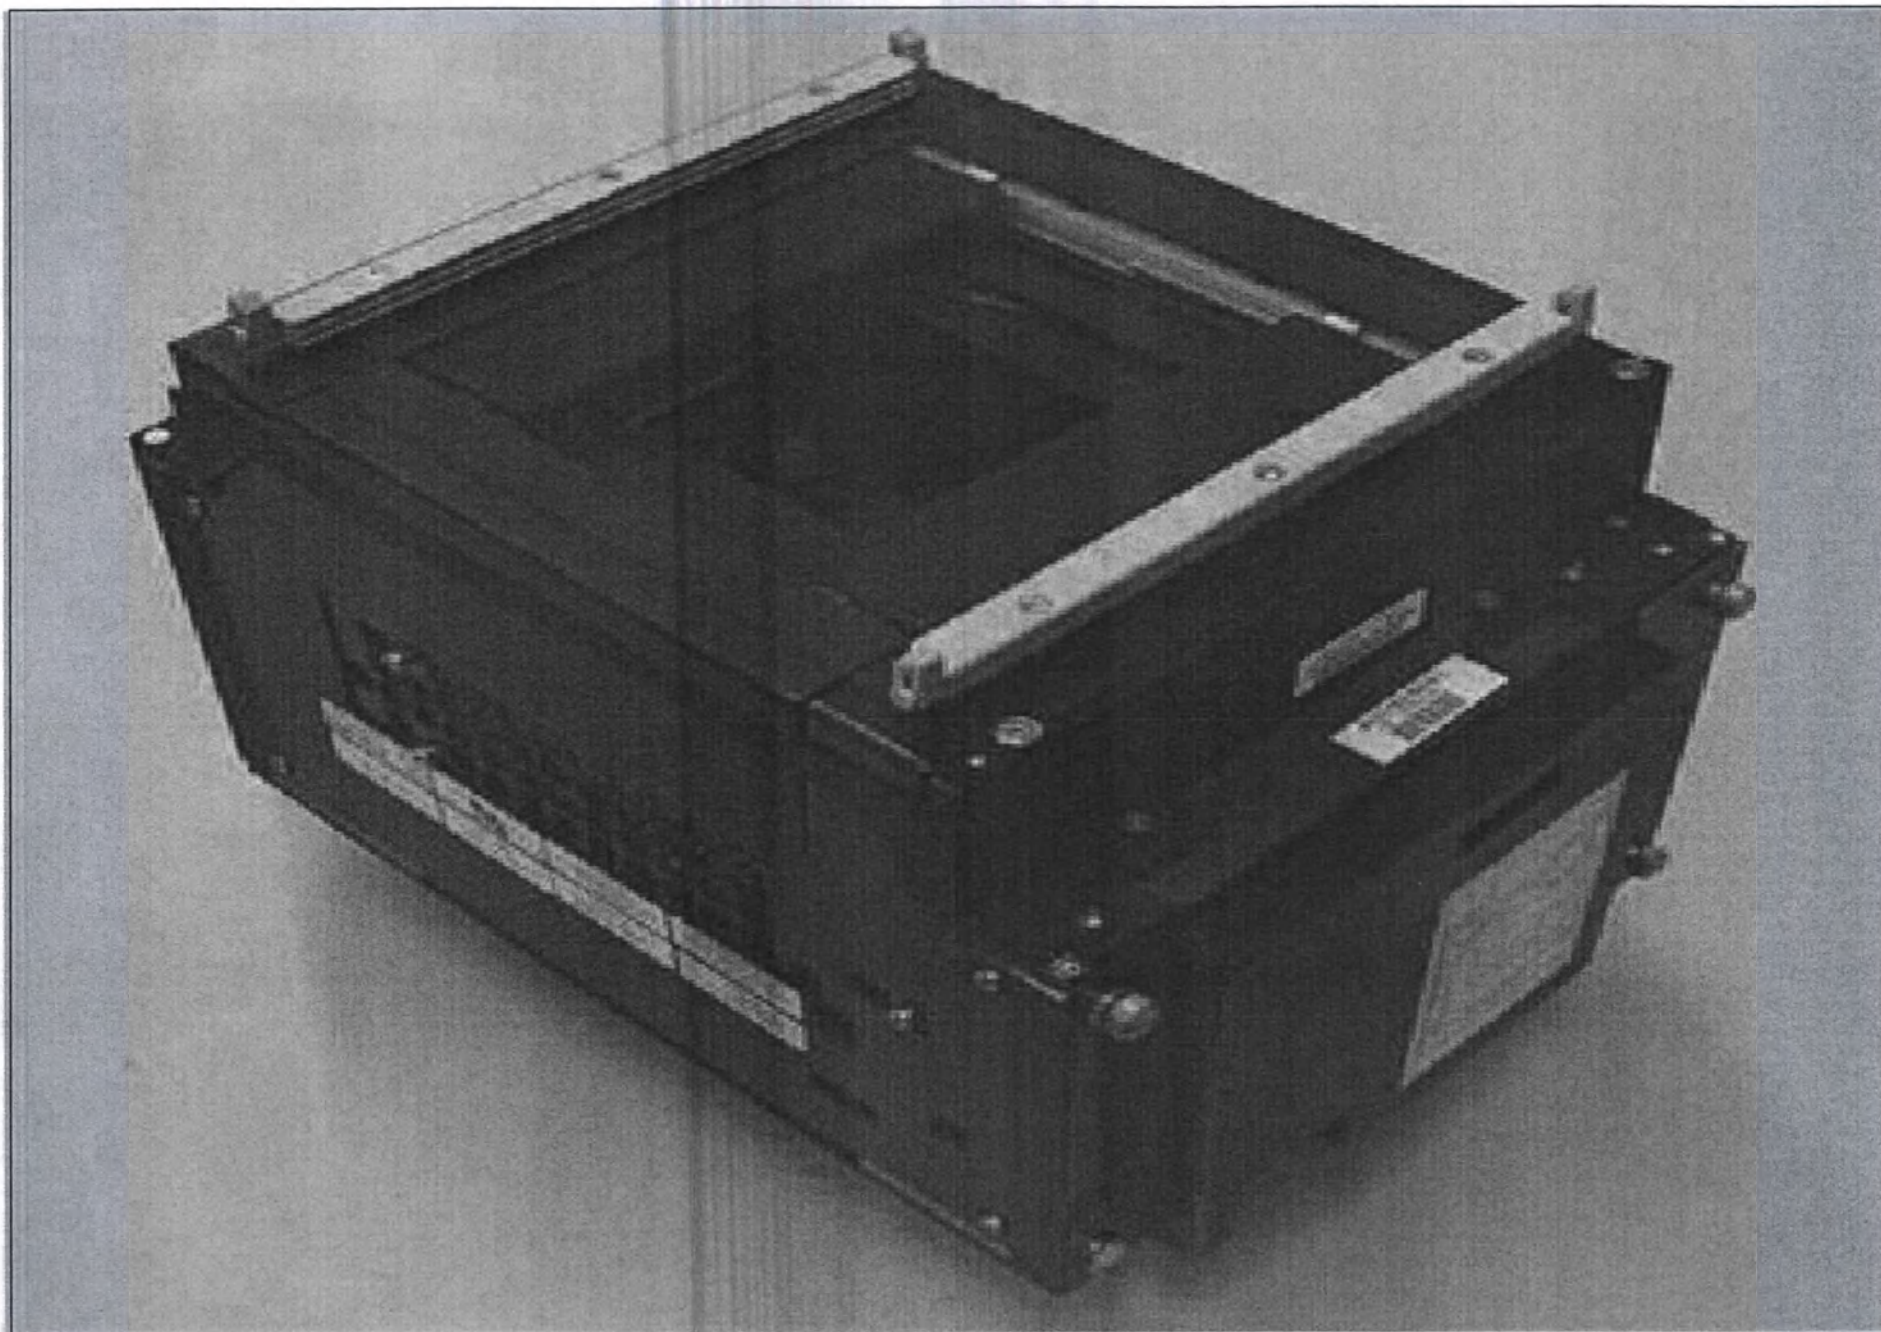


1.2. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

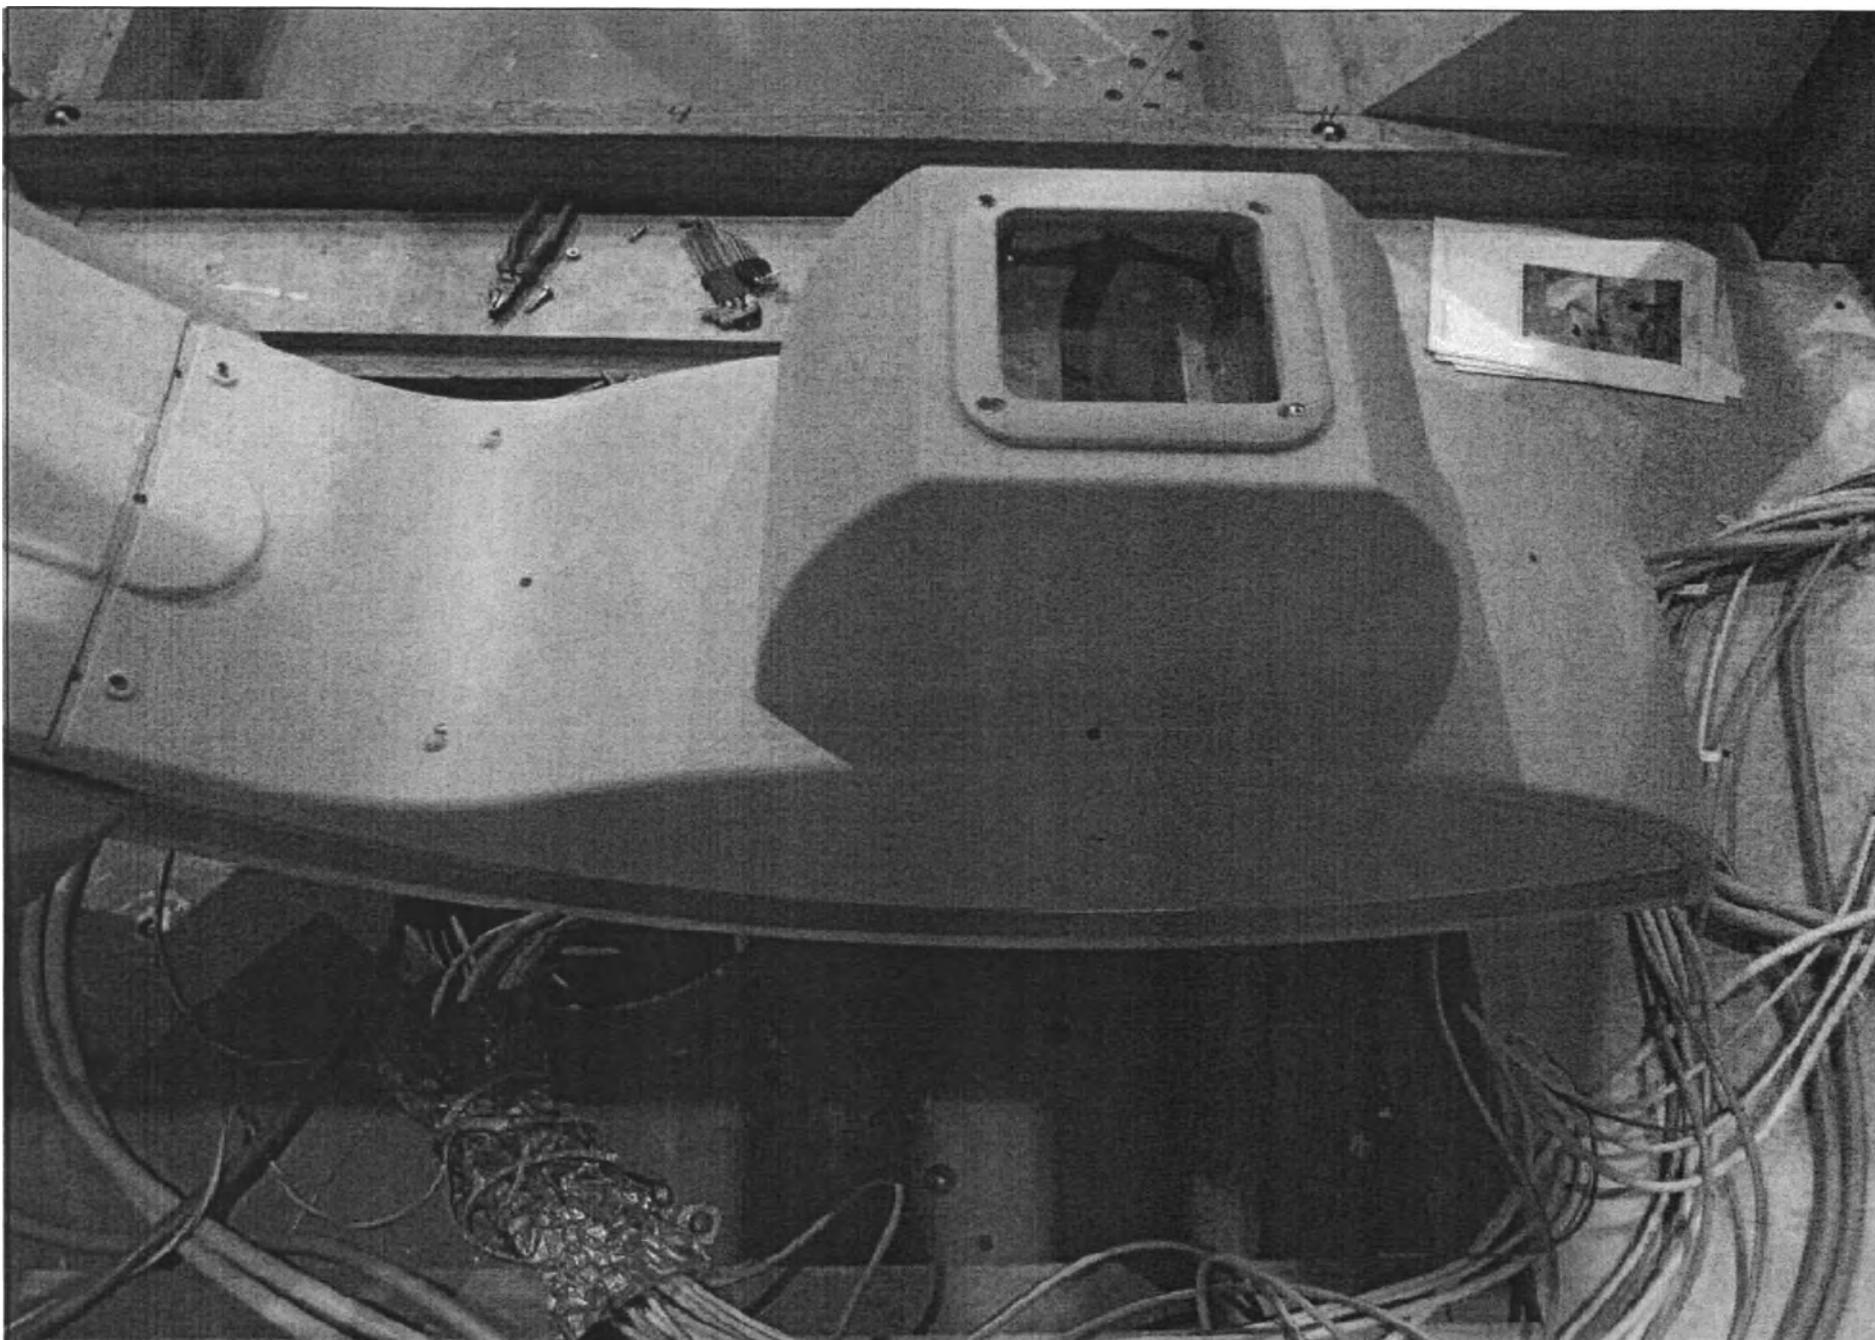


1.д. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

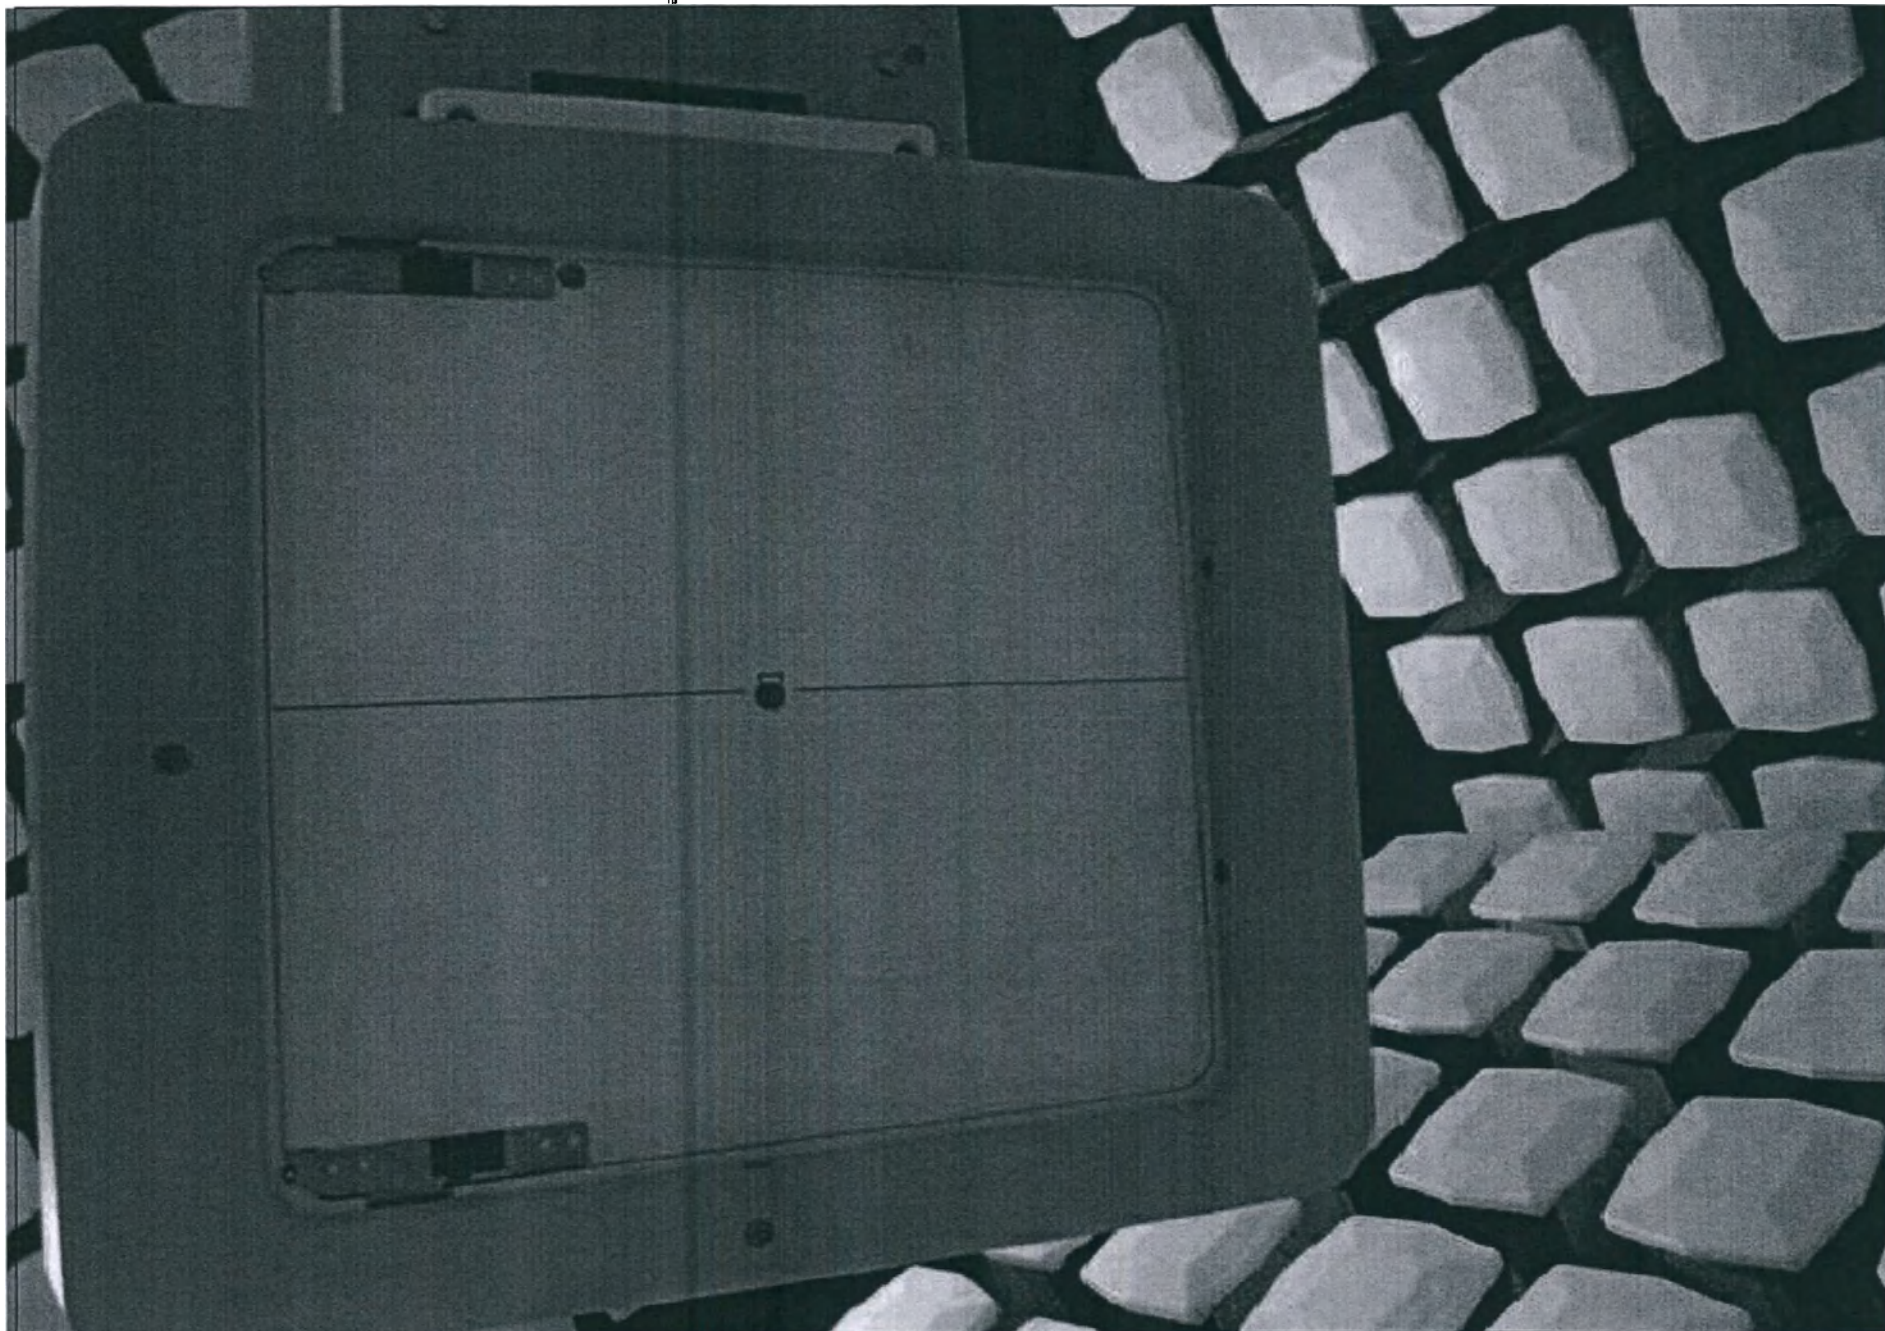


1.е. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С12.

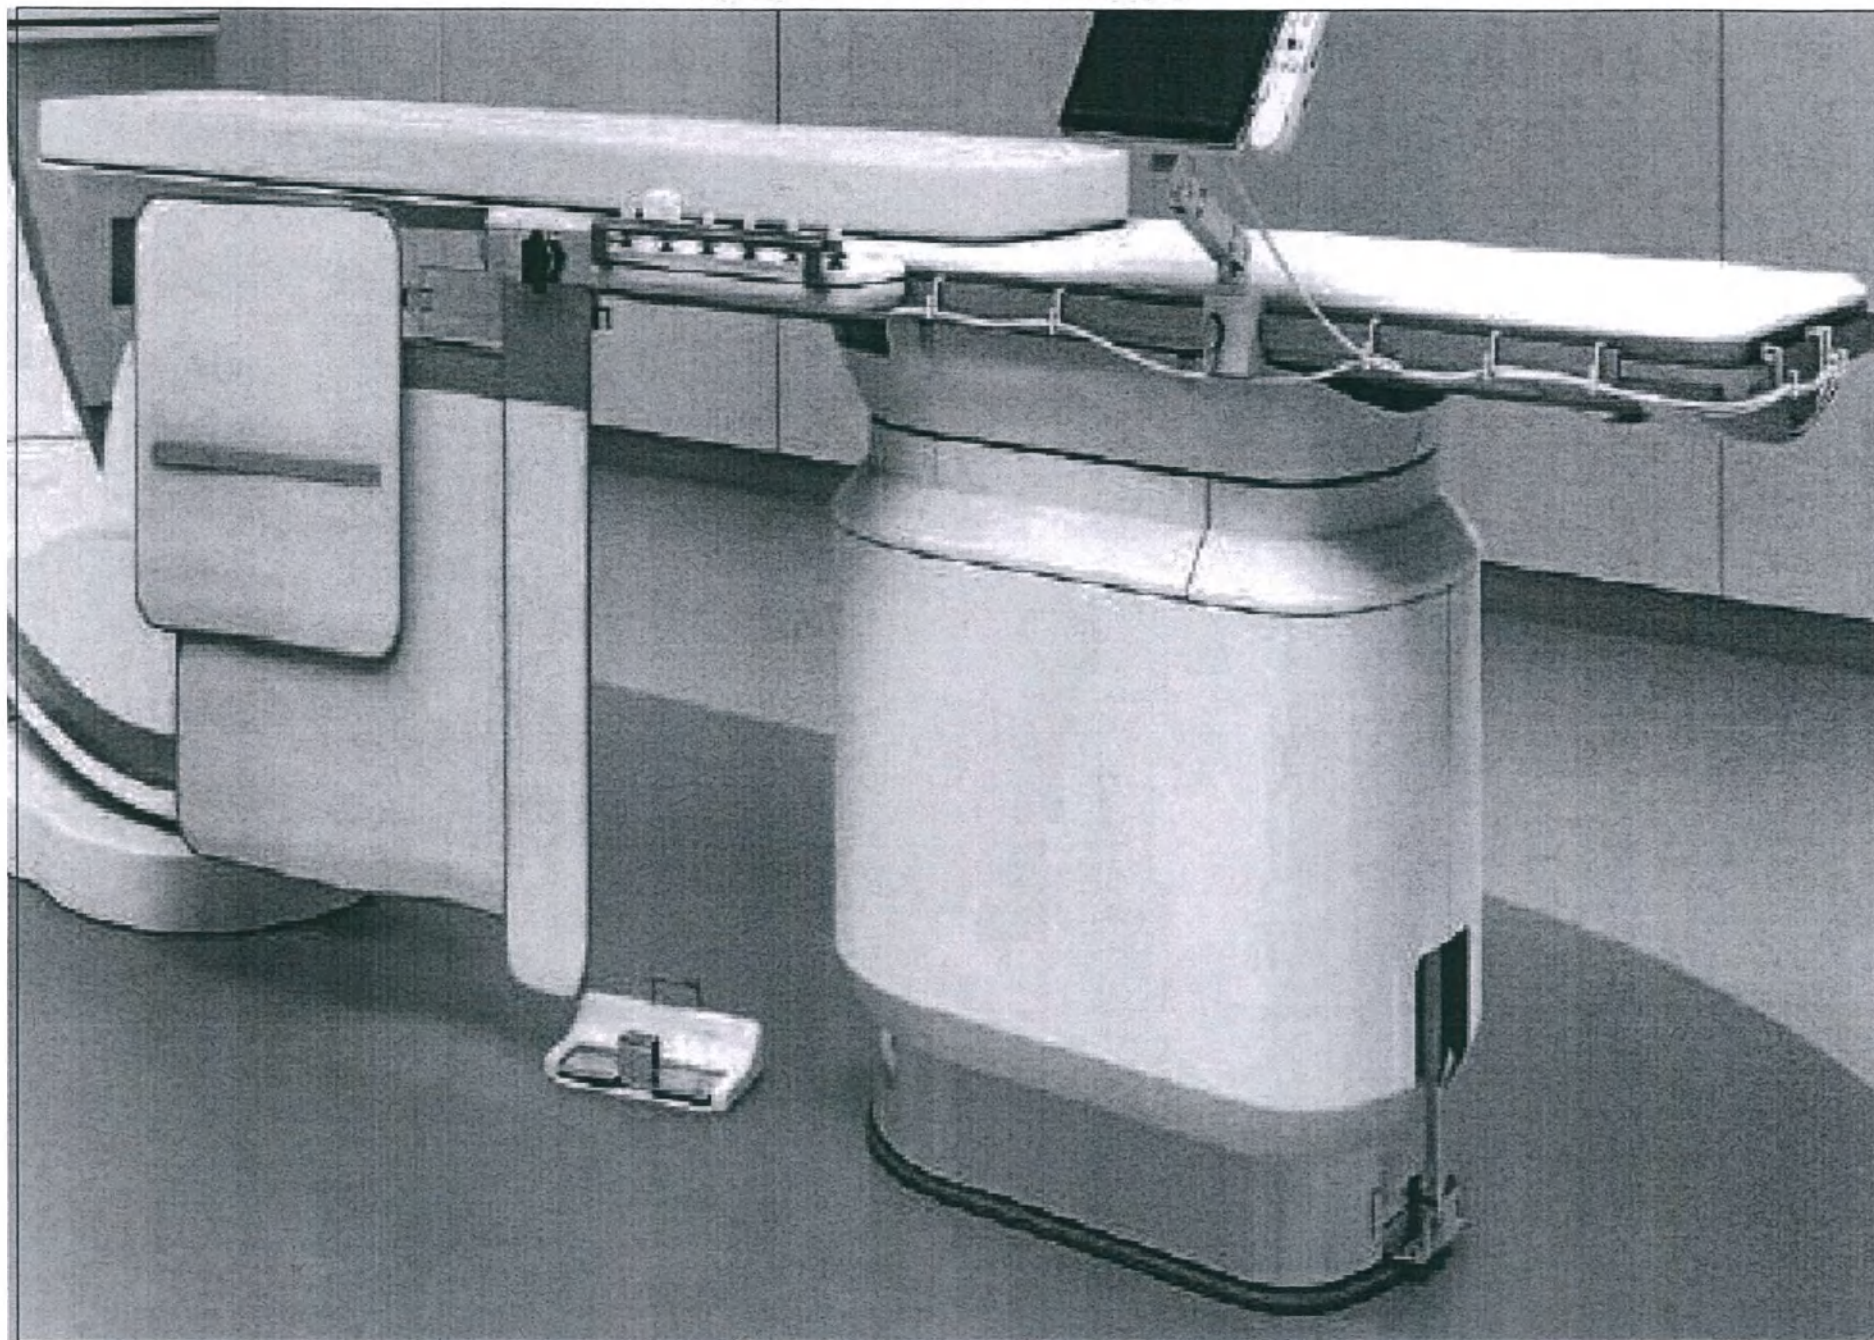


2.а. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

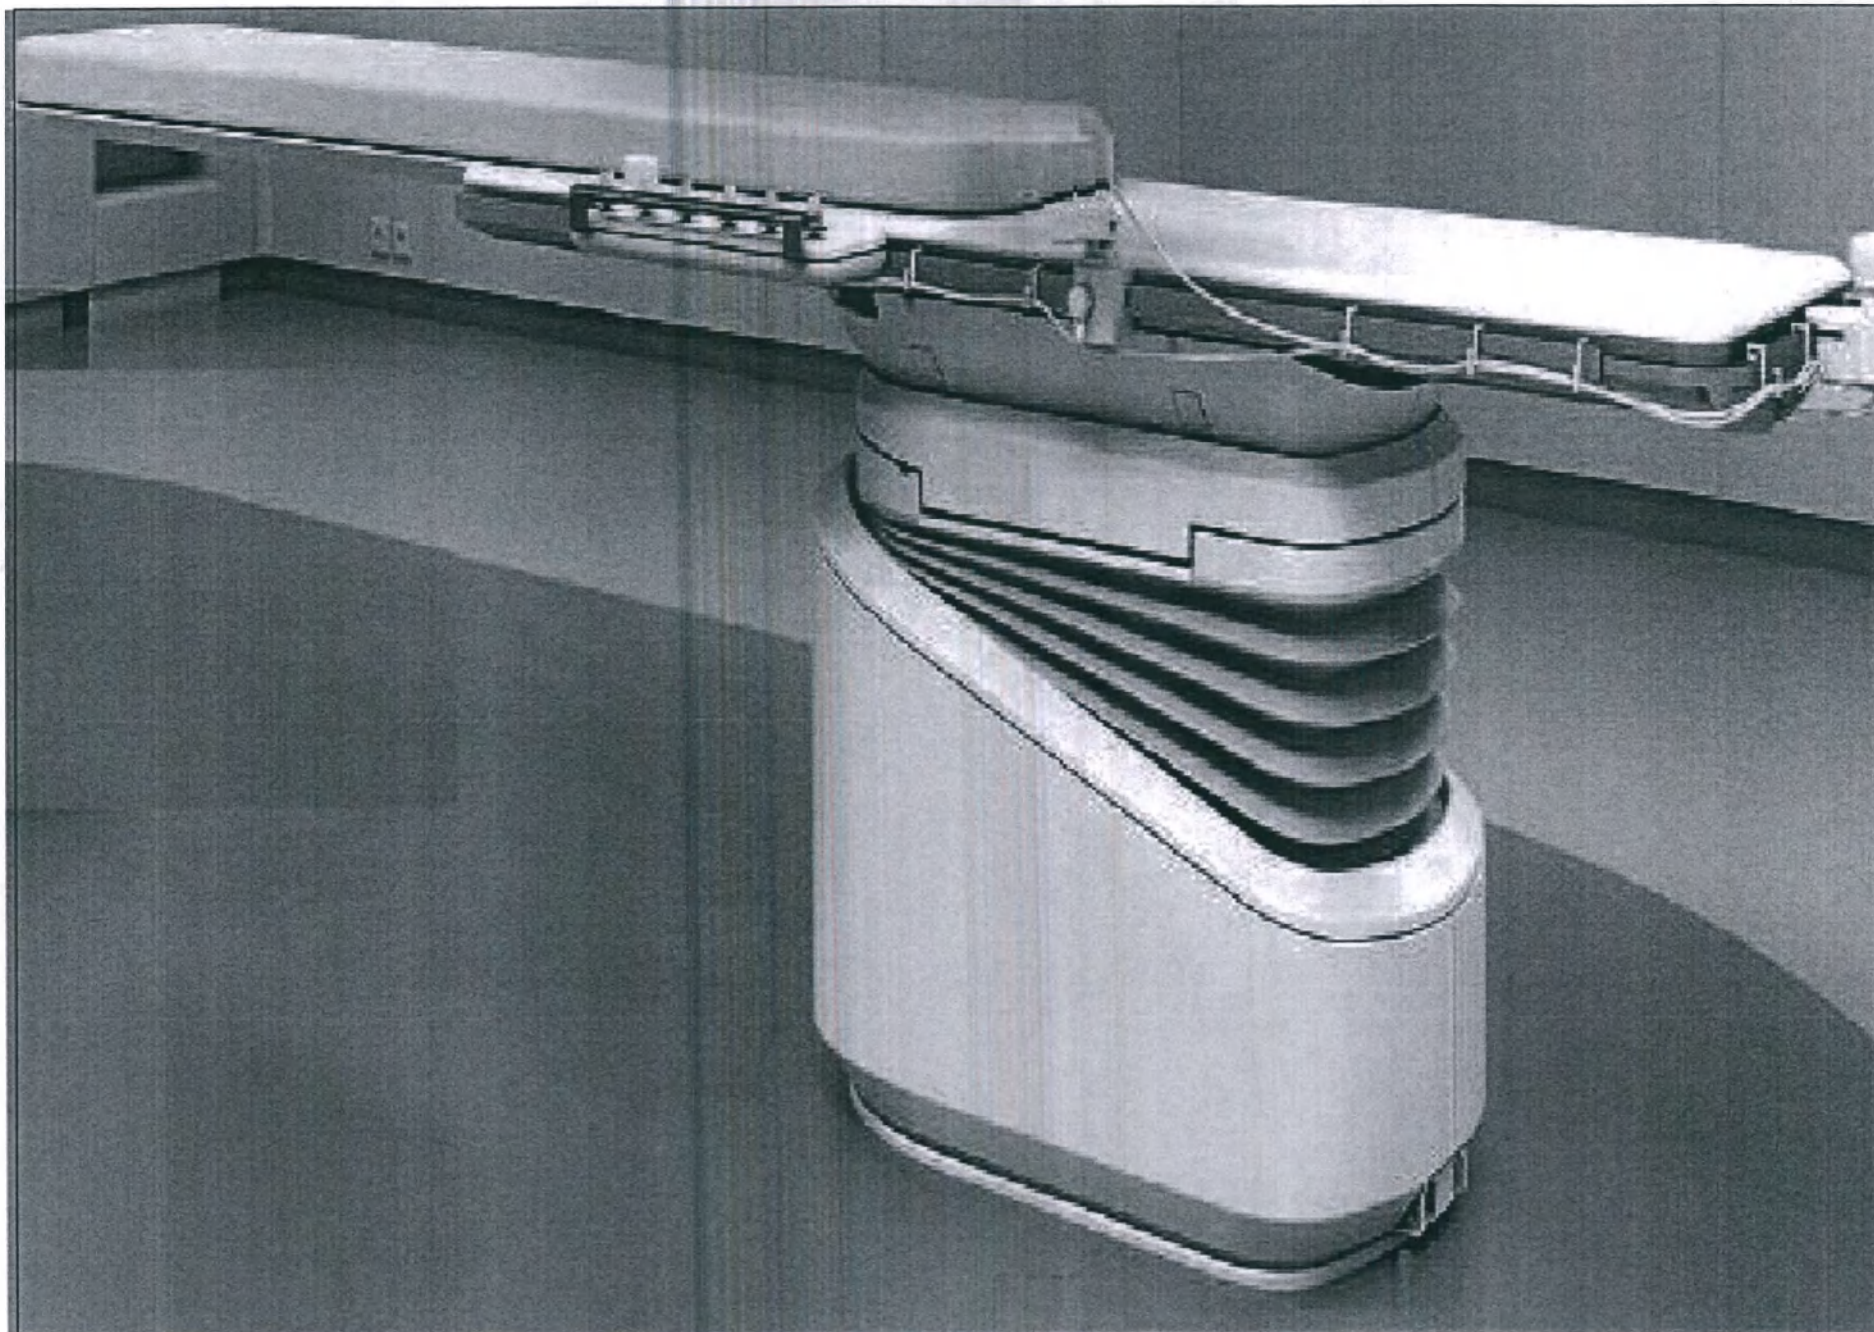


2.6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

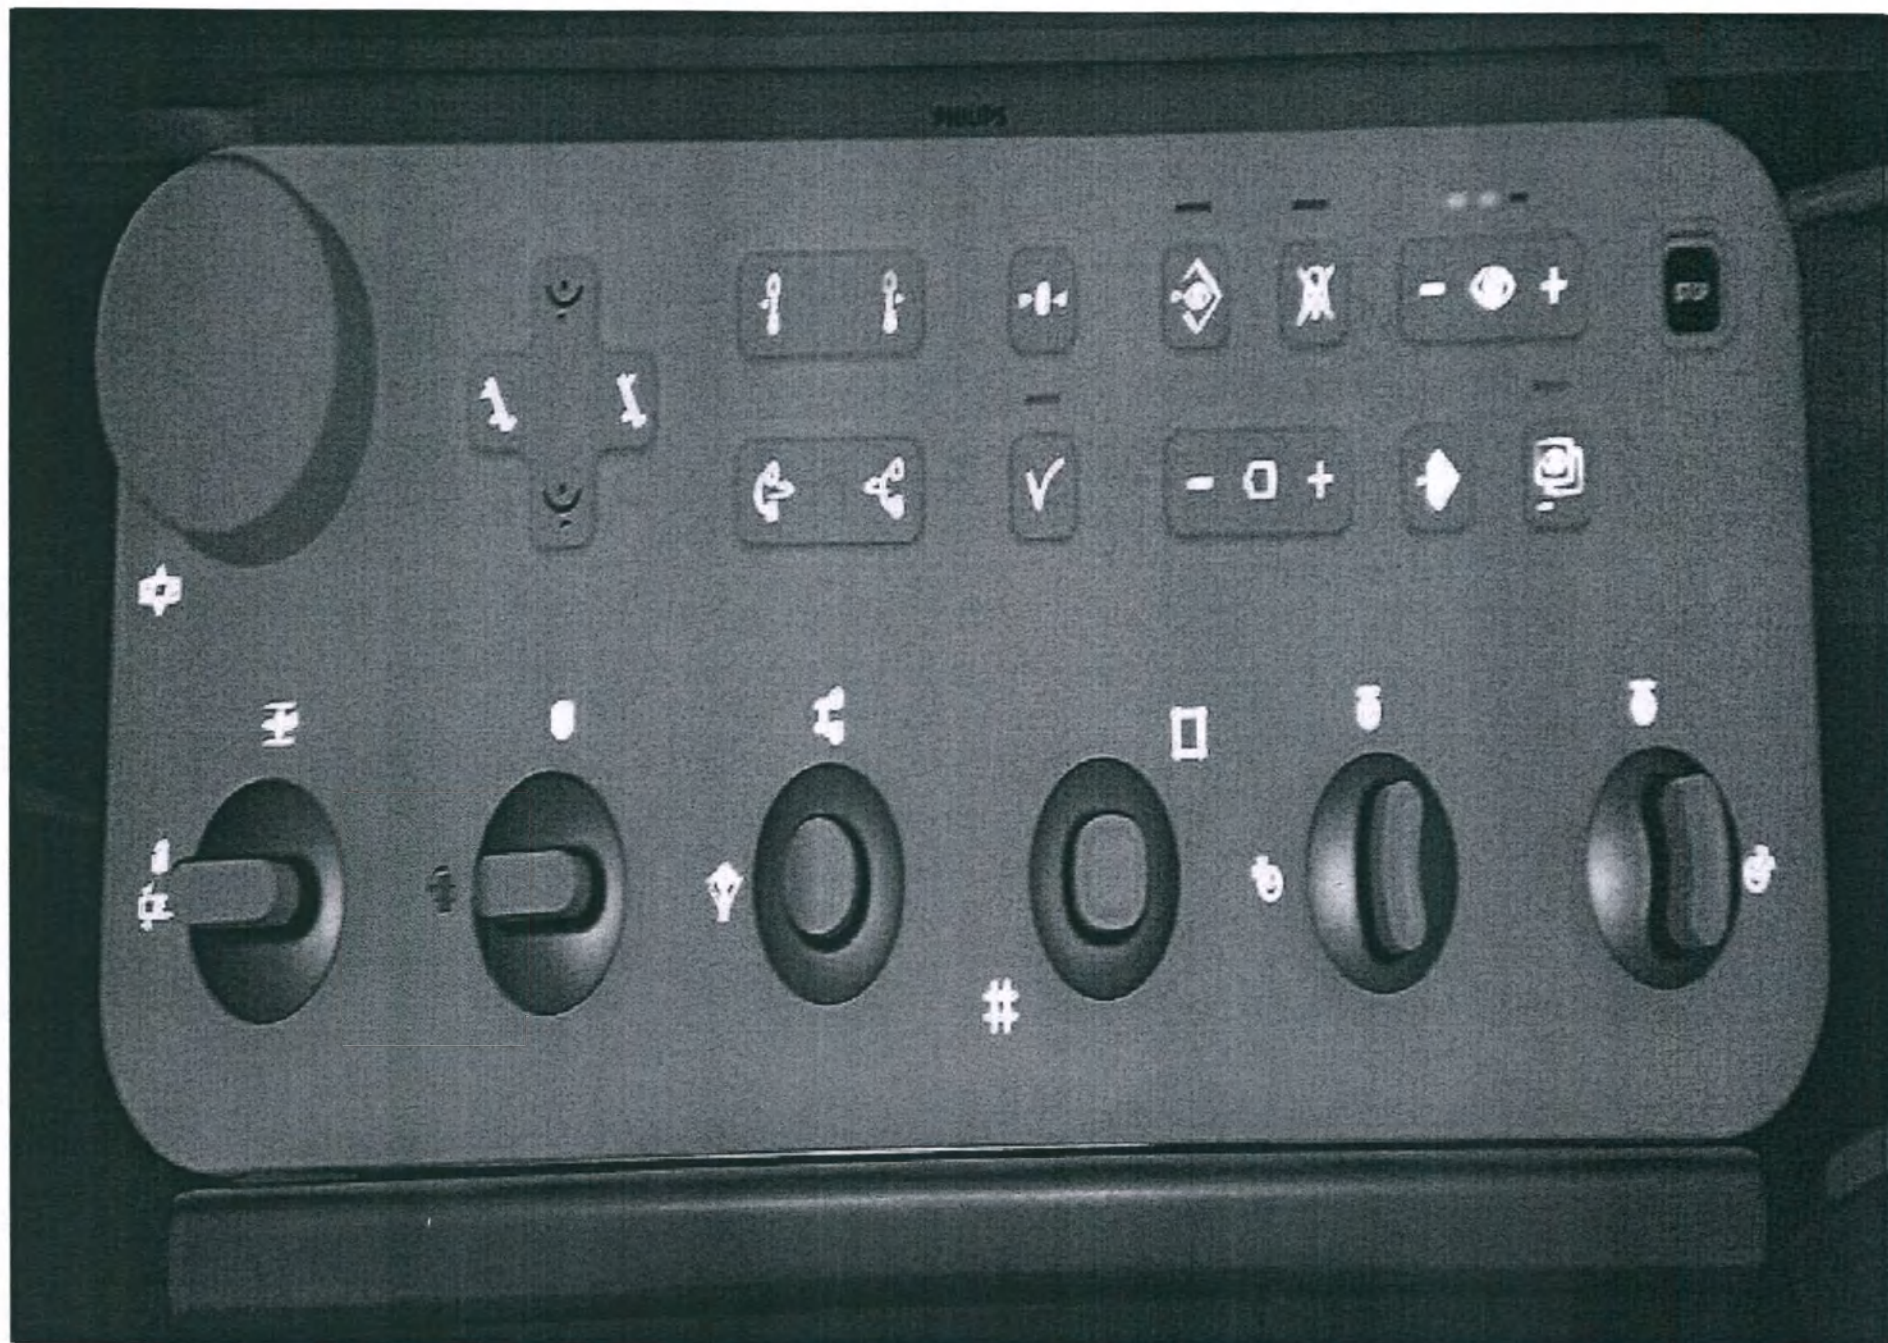


3. Модуль управления, не более 4 шт.

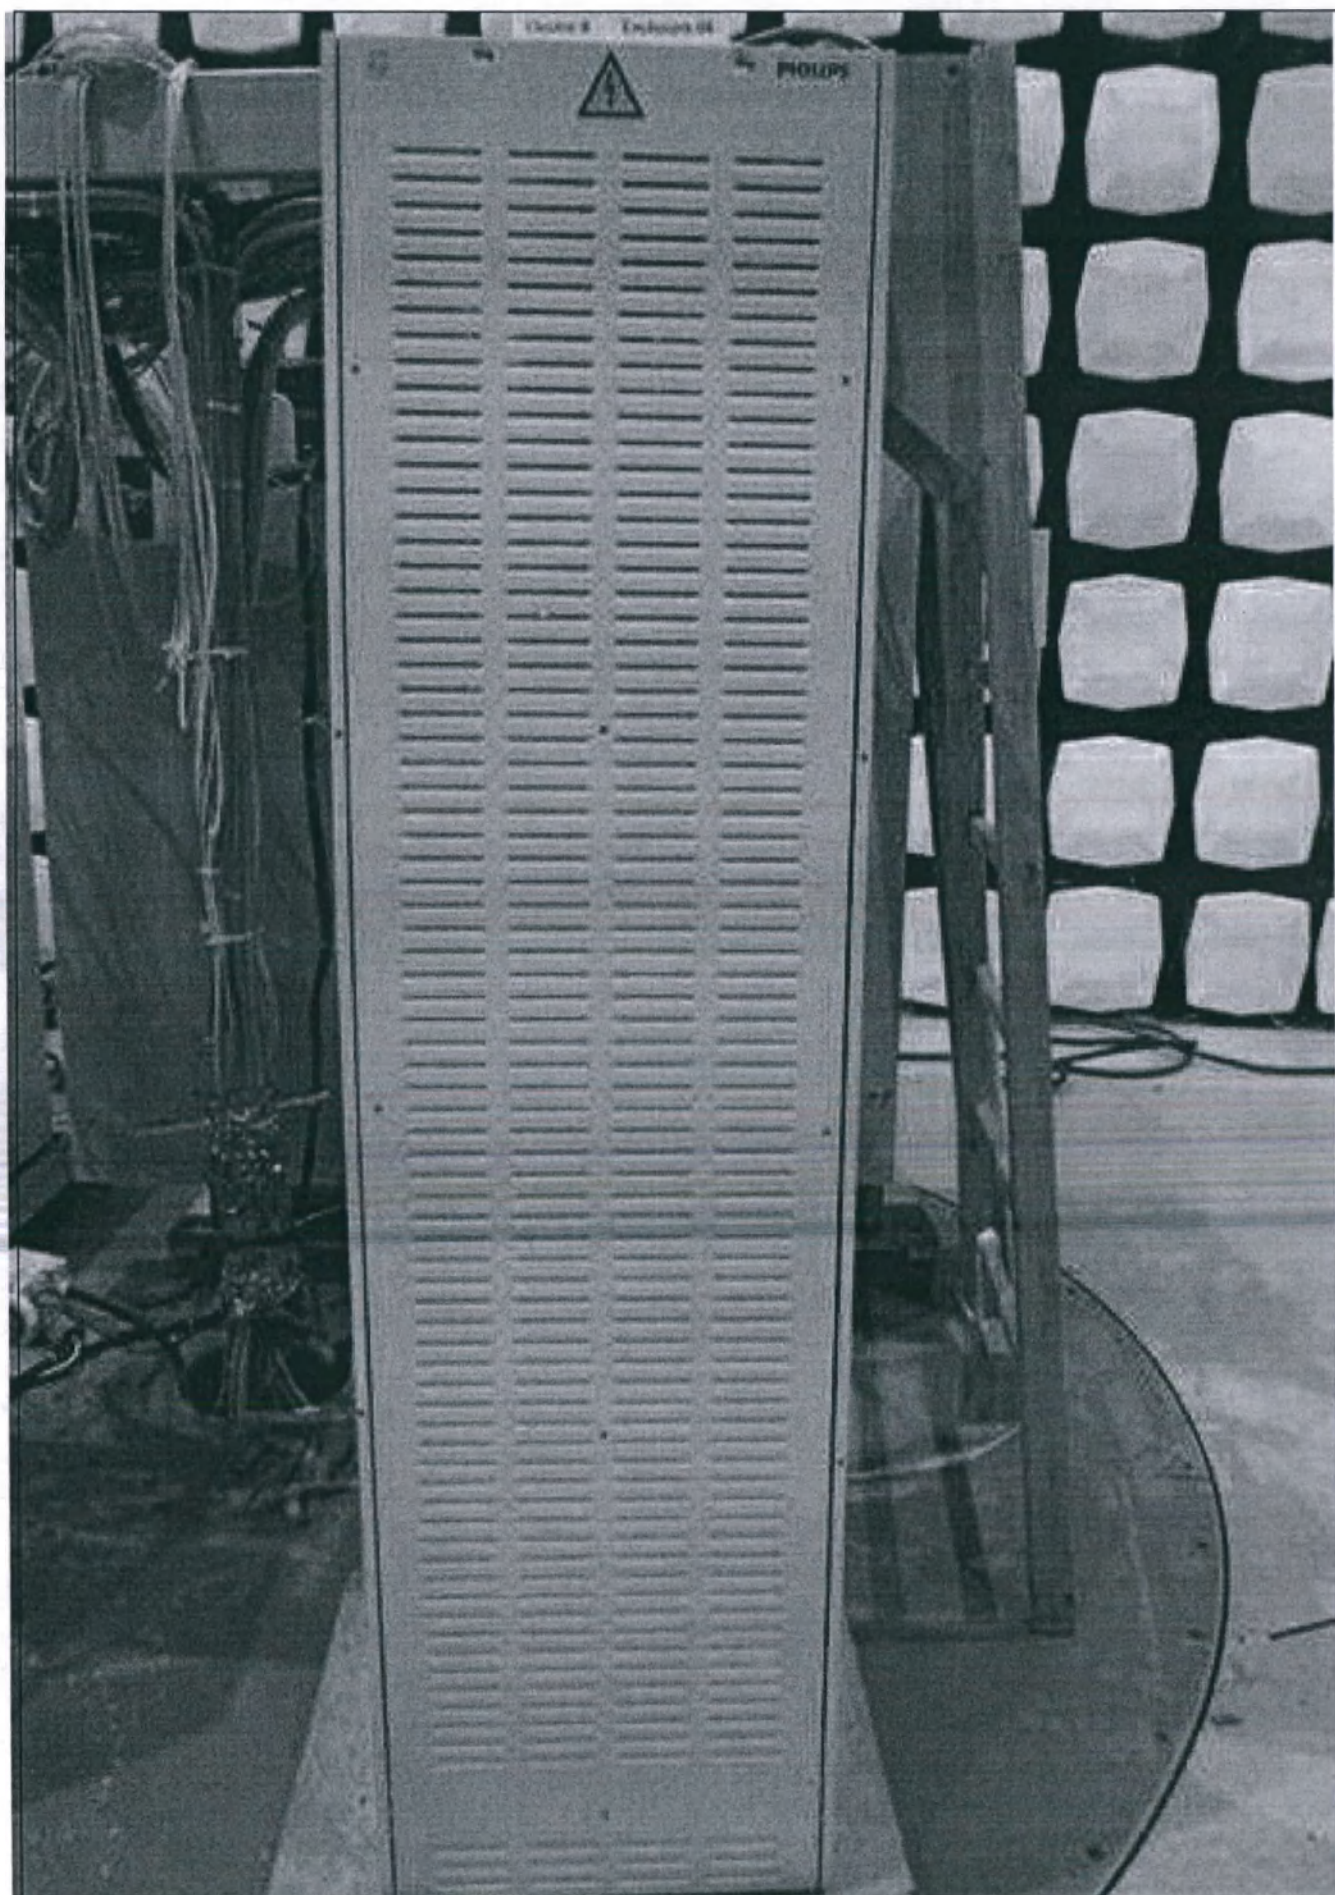


4.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

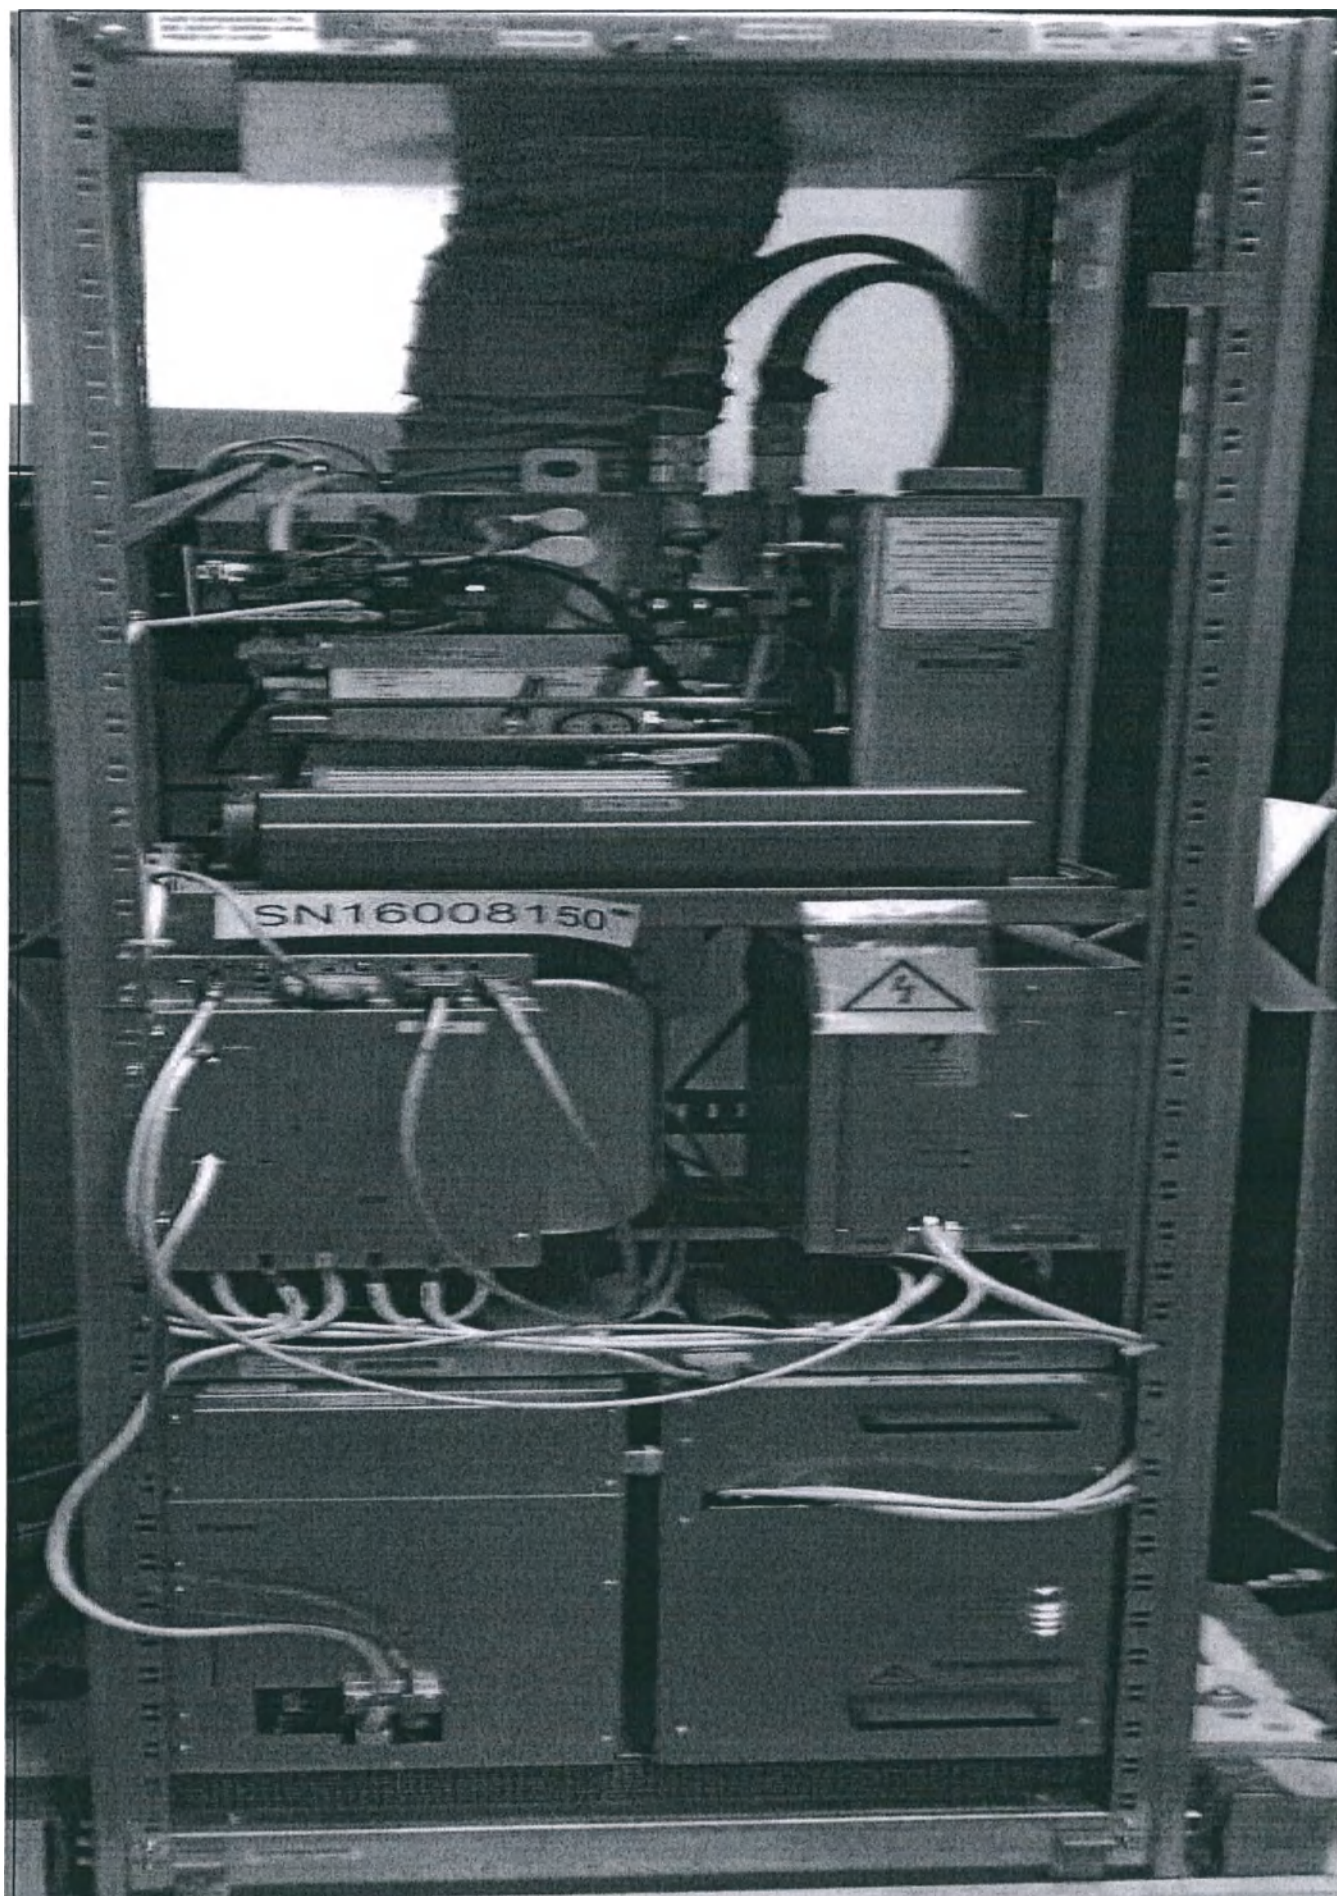


4.6. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

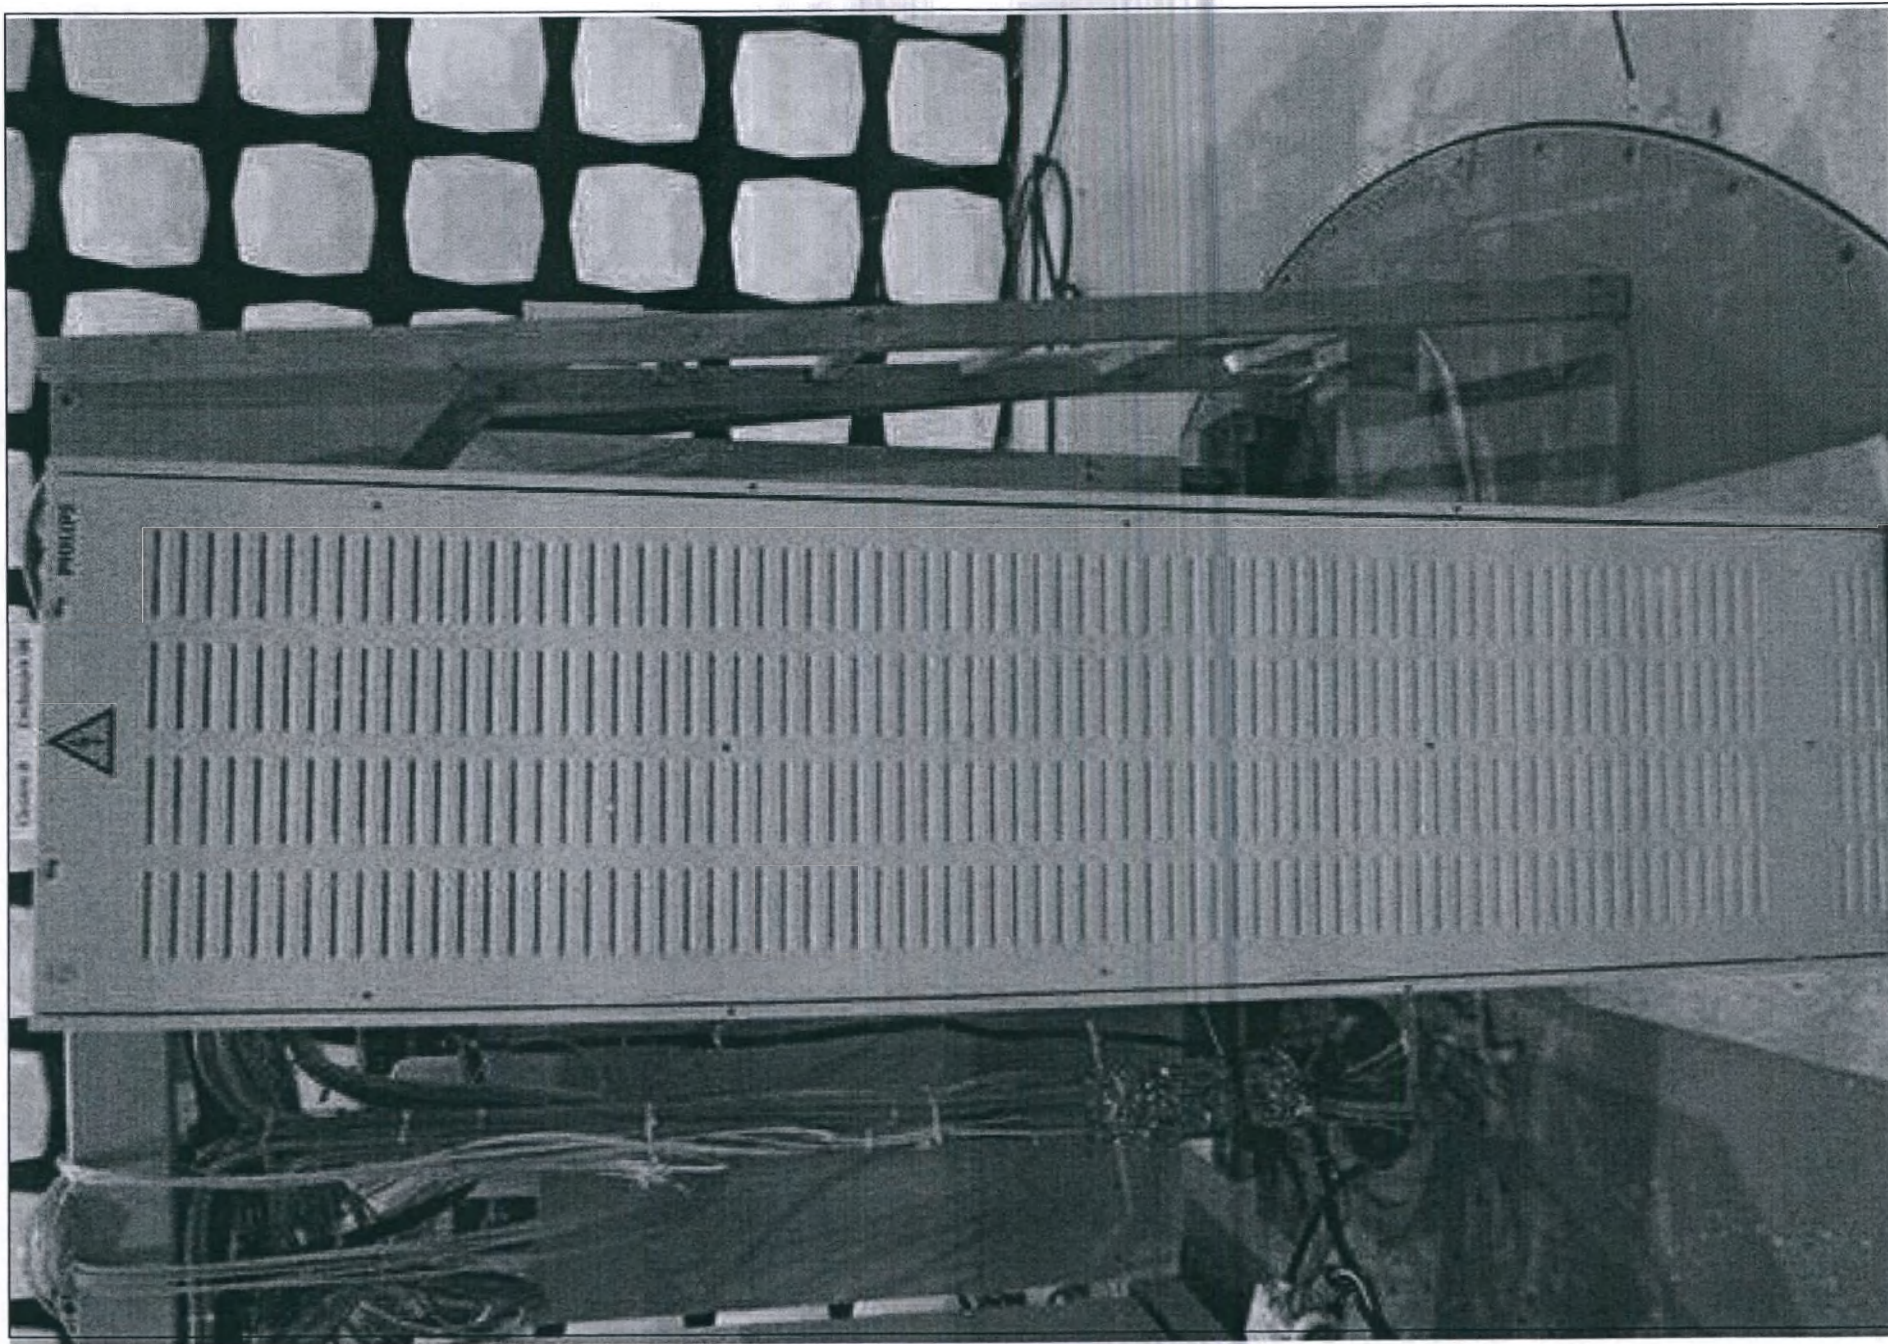


5.а. Шкаф управления.

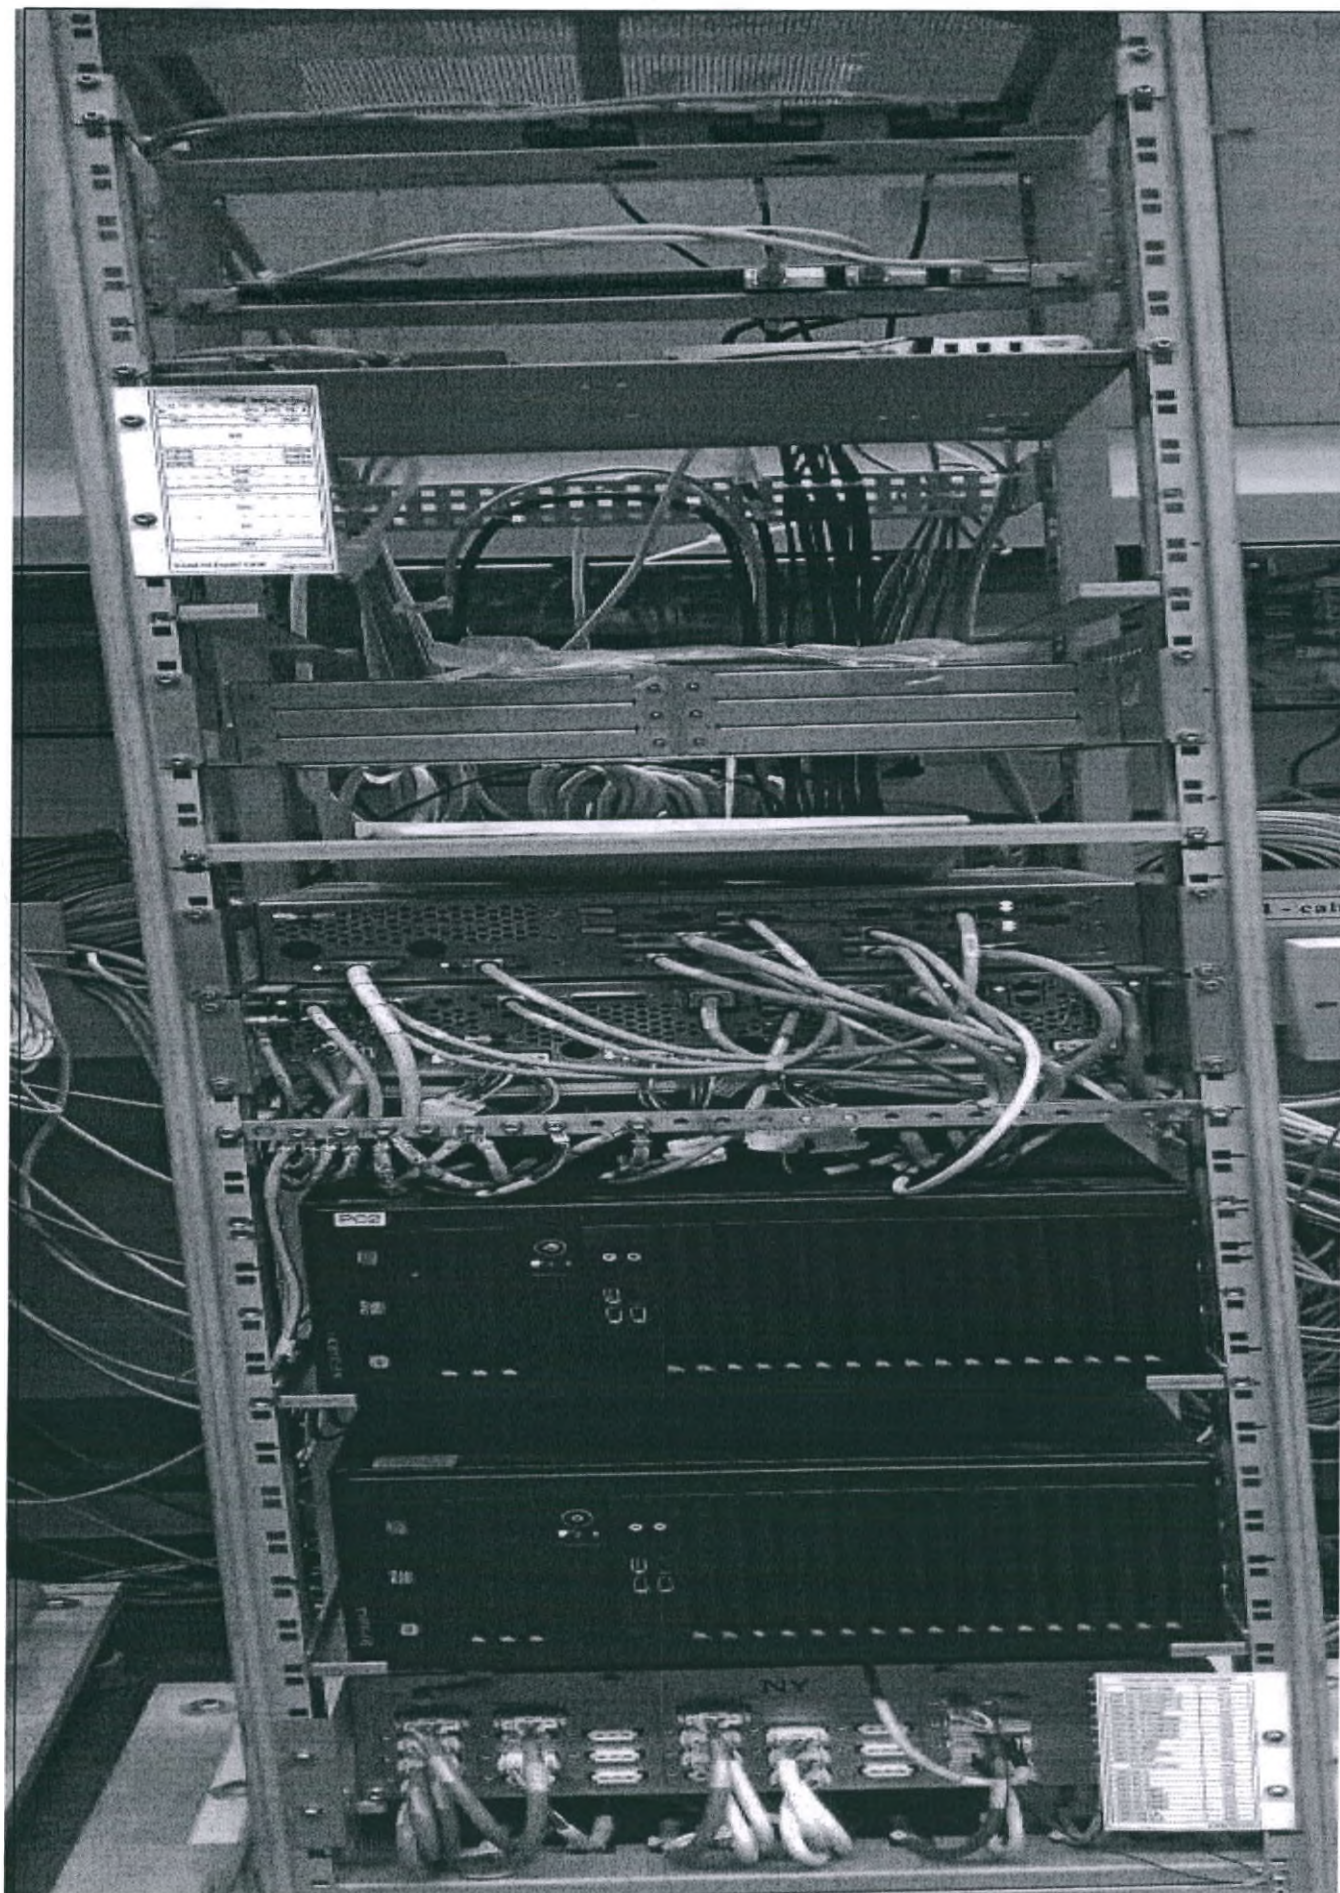

5.6. Шкаф управления.

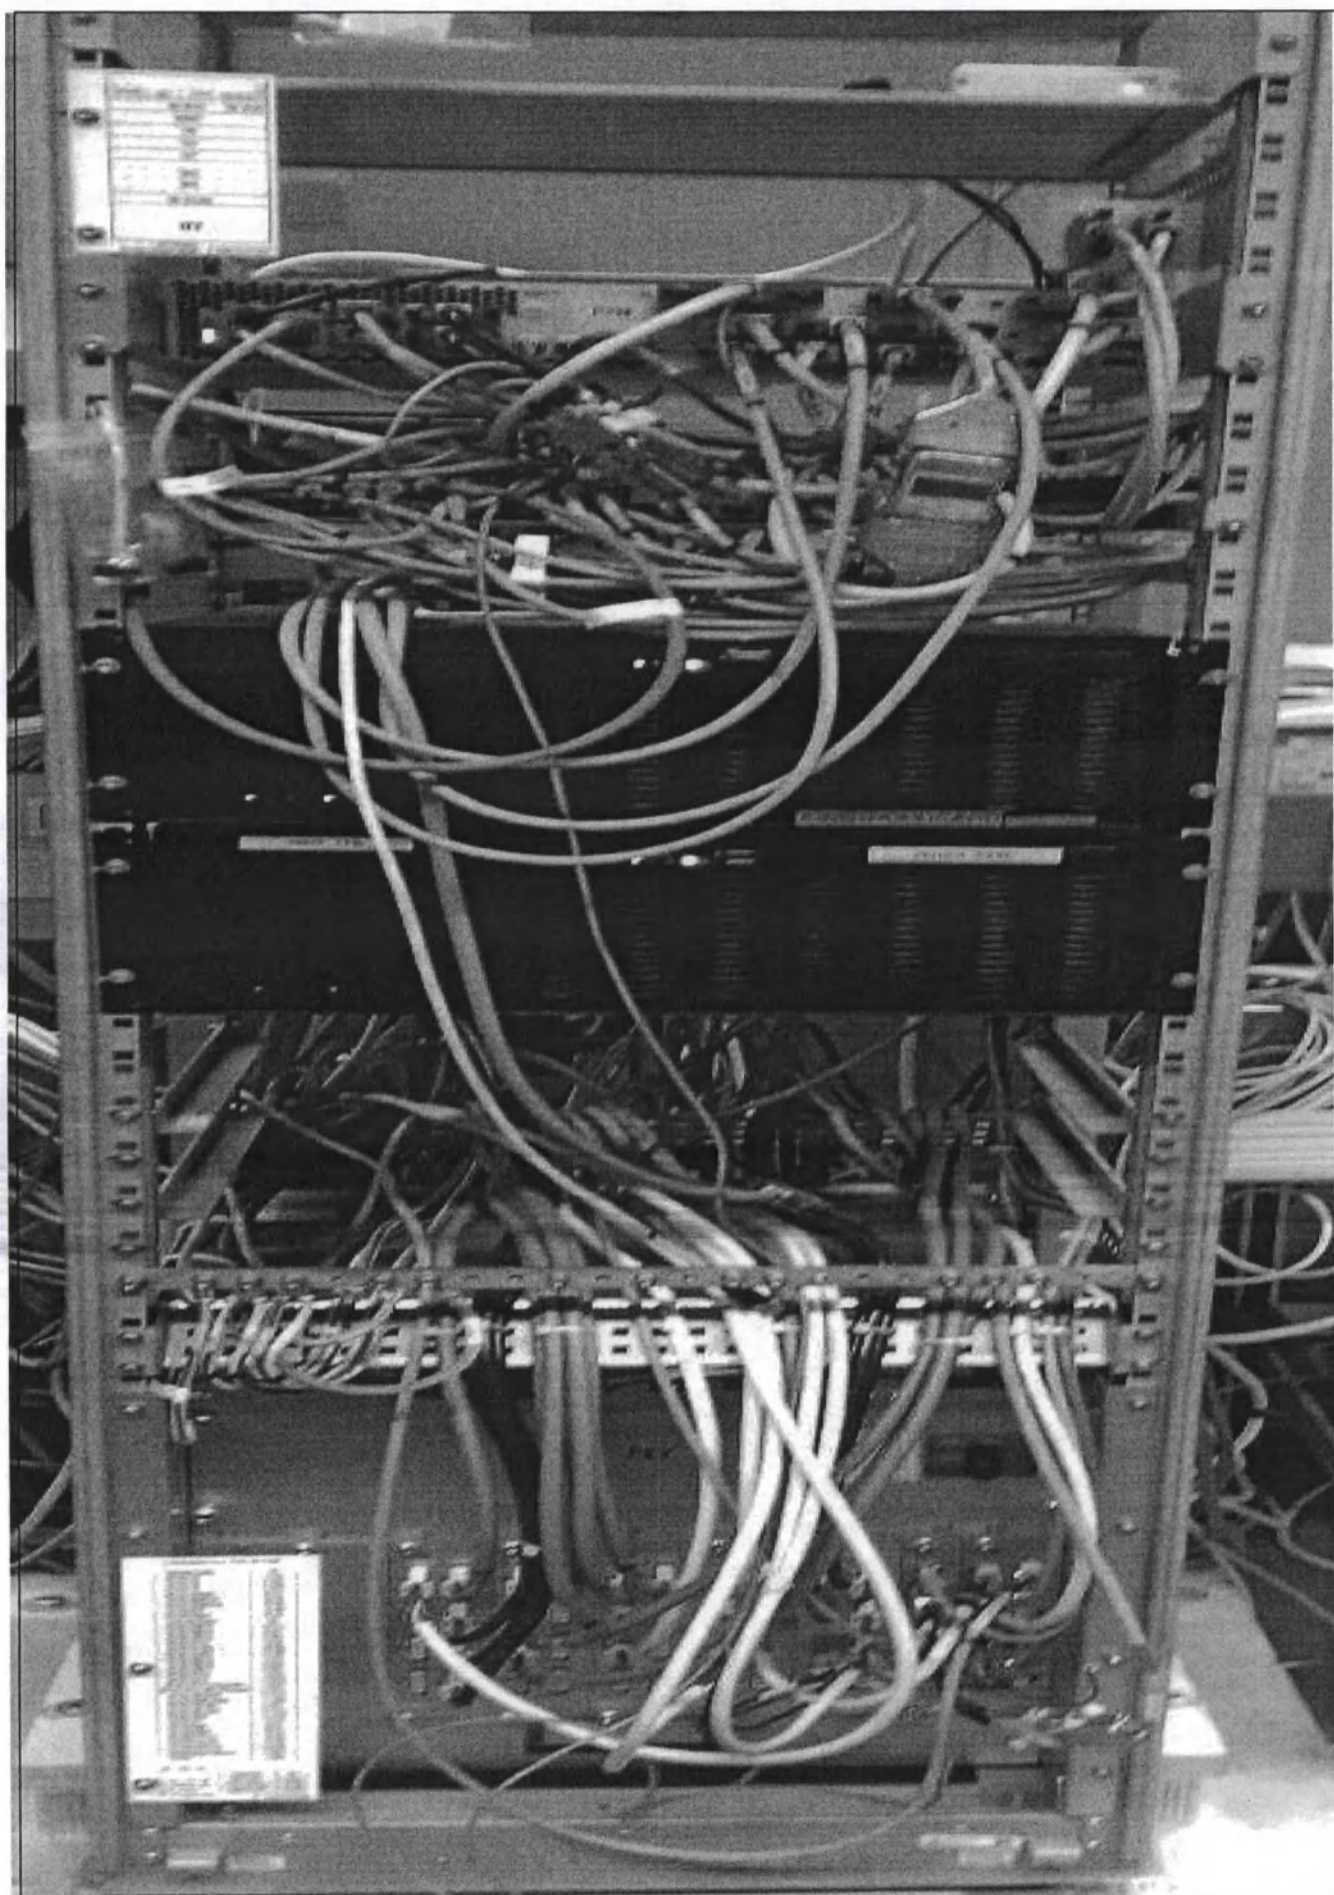


б.а. Распределительный щит.

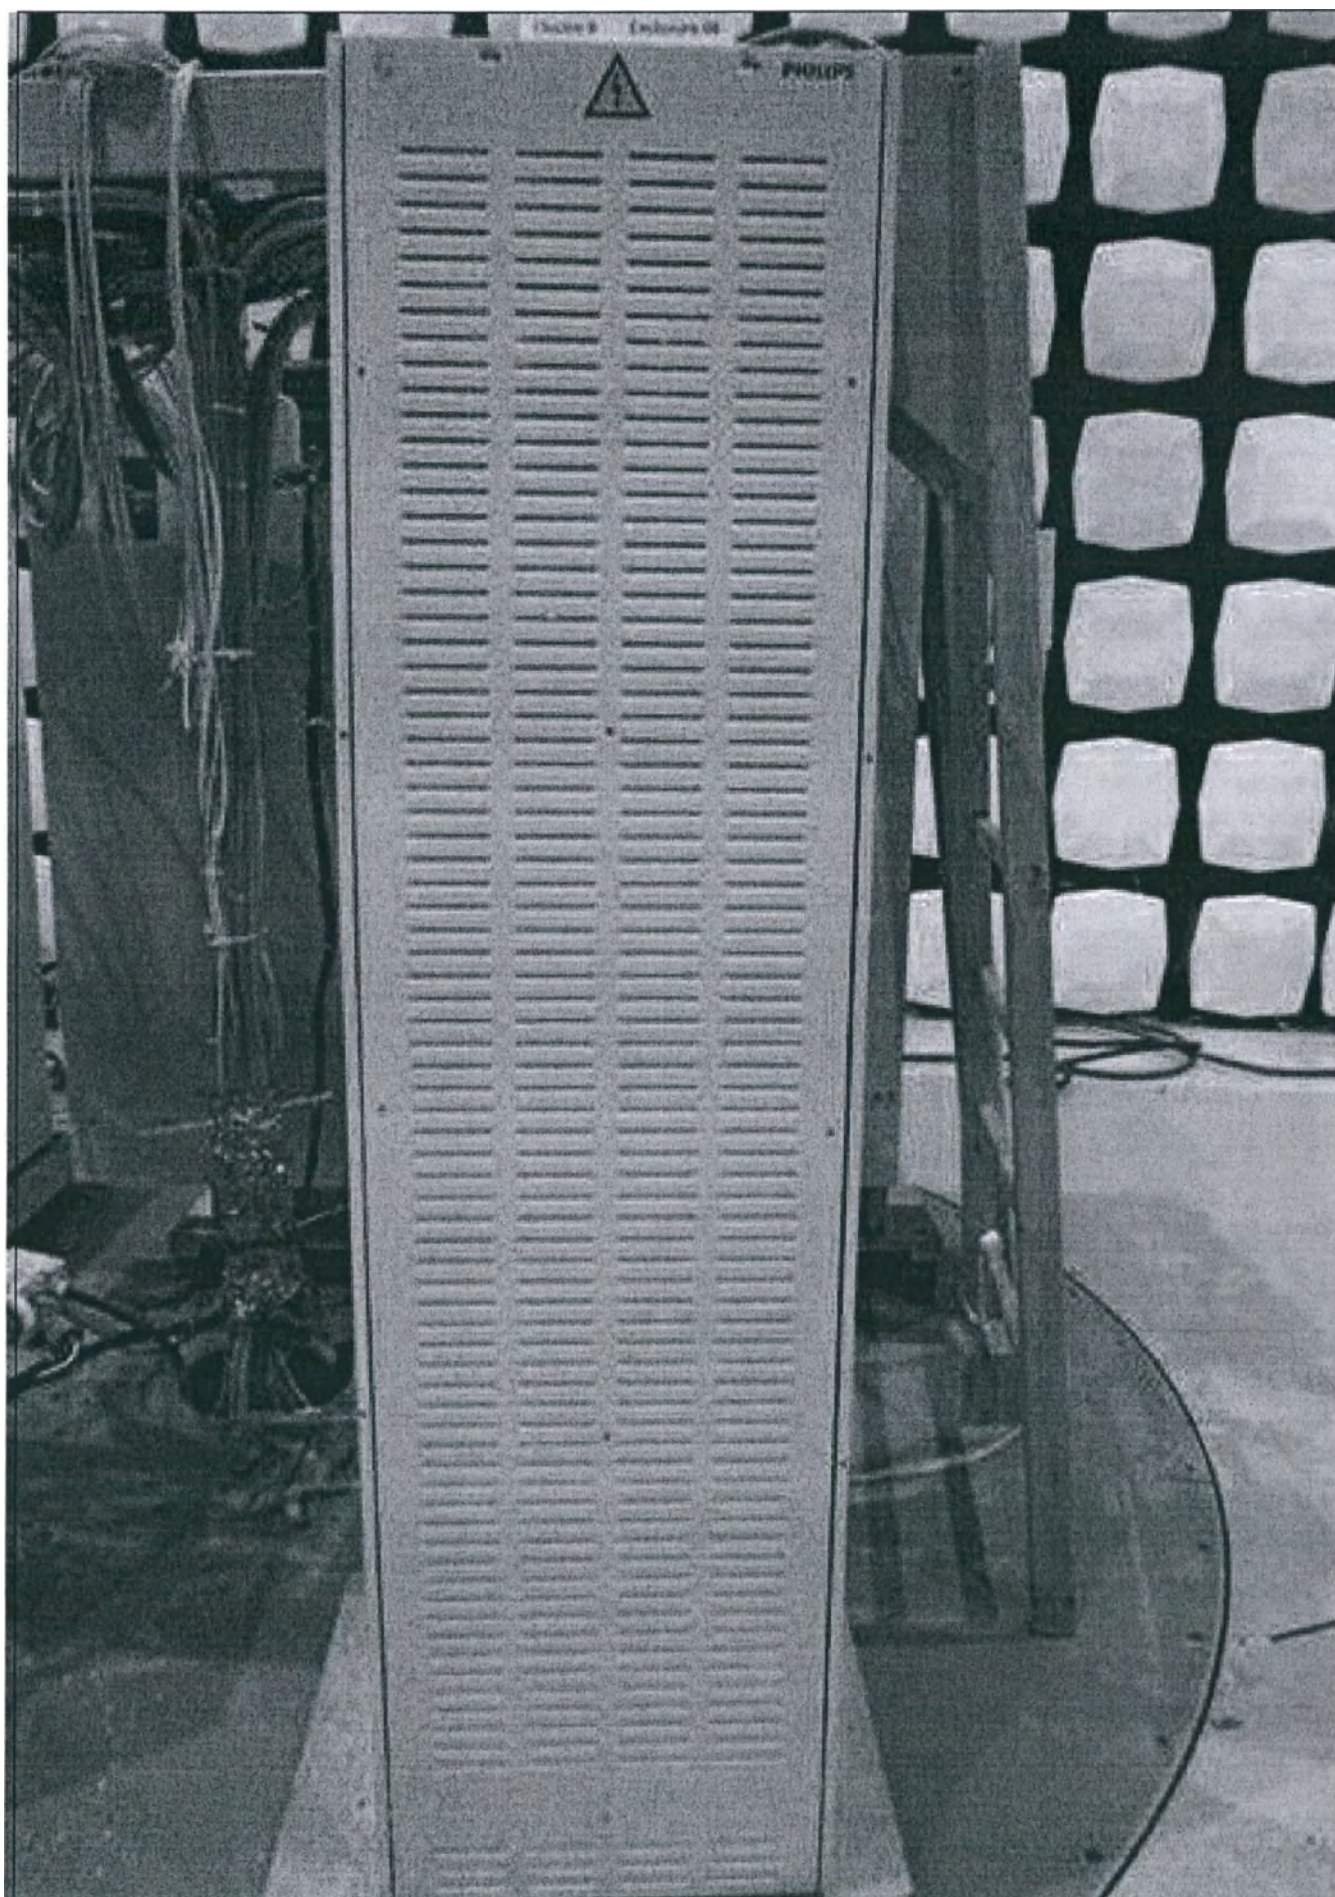


6.6. Распределительный щит.




7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

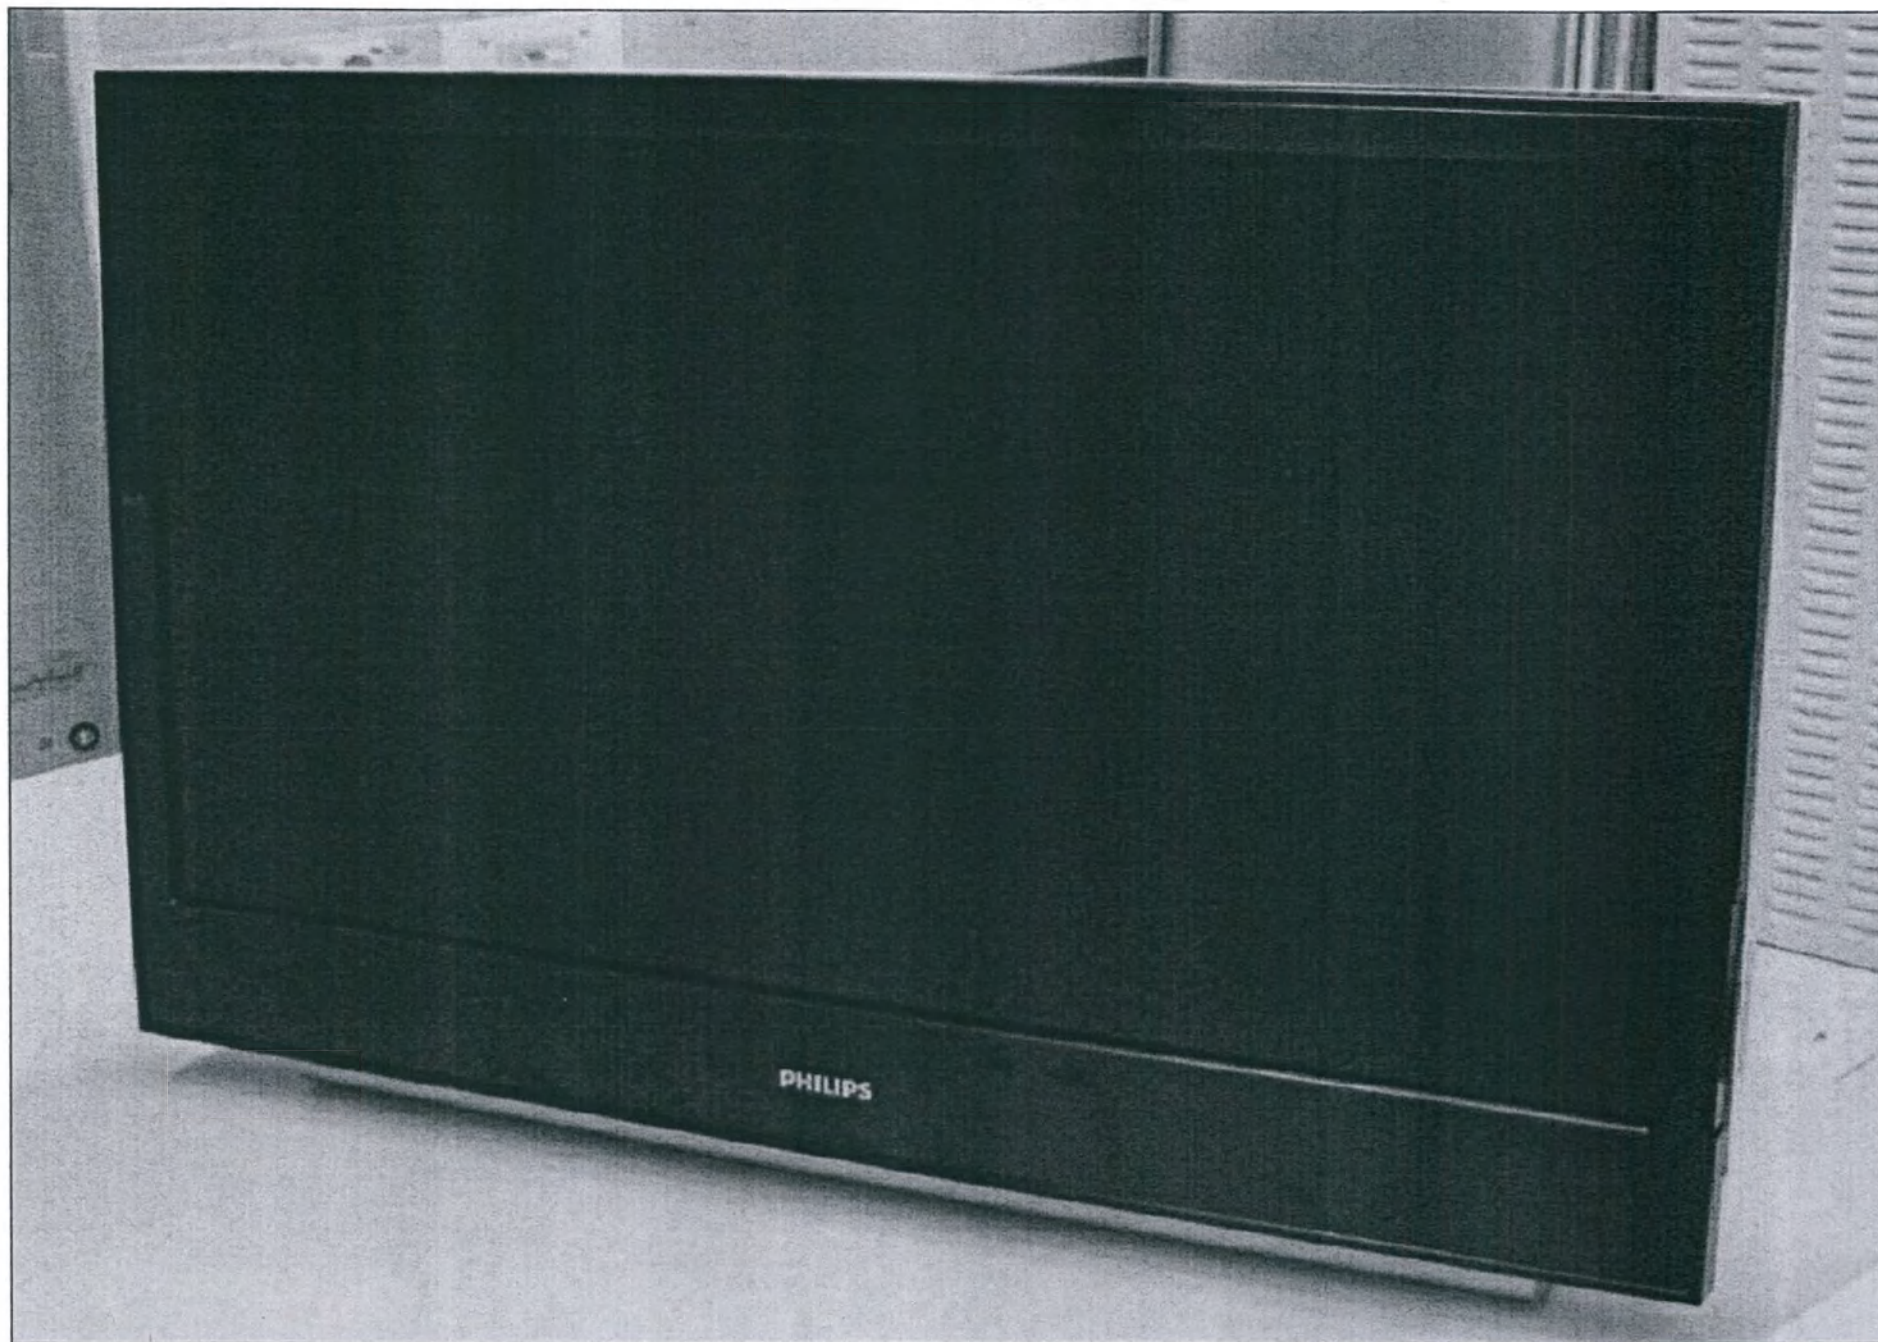

8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

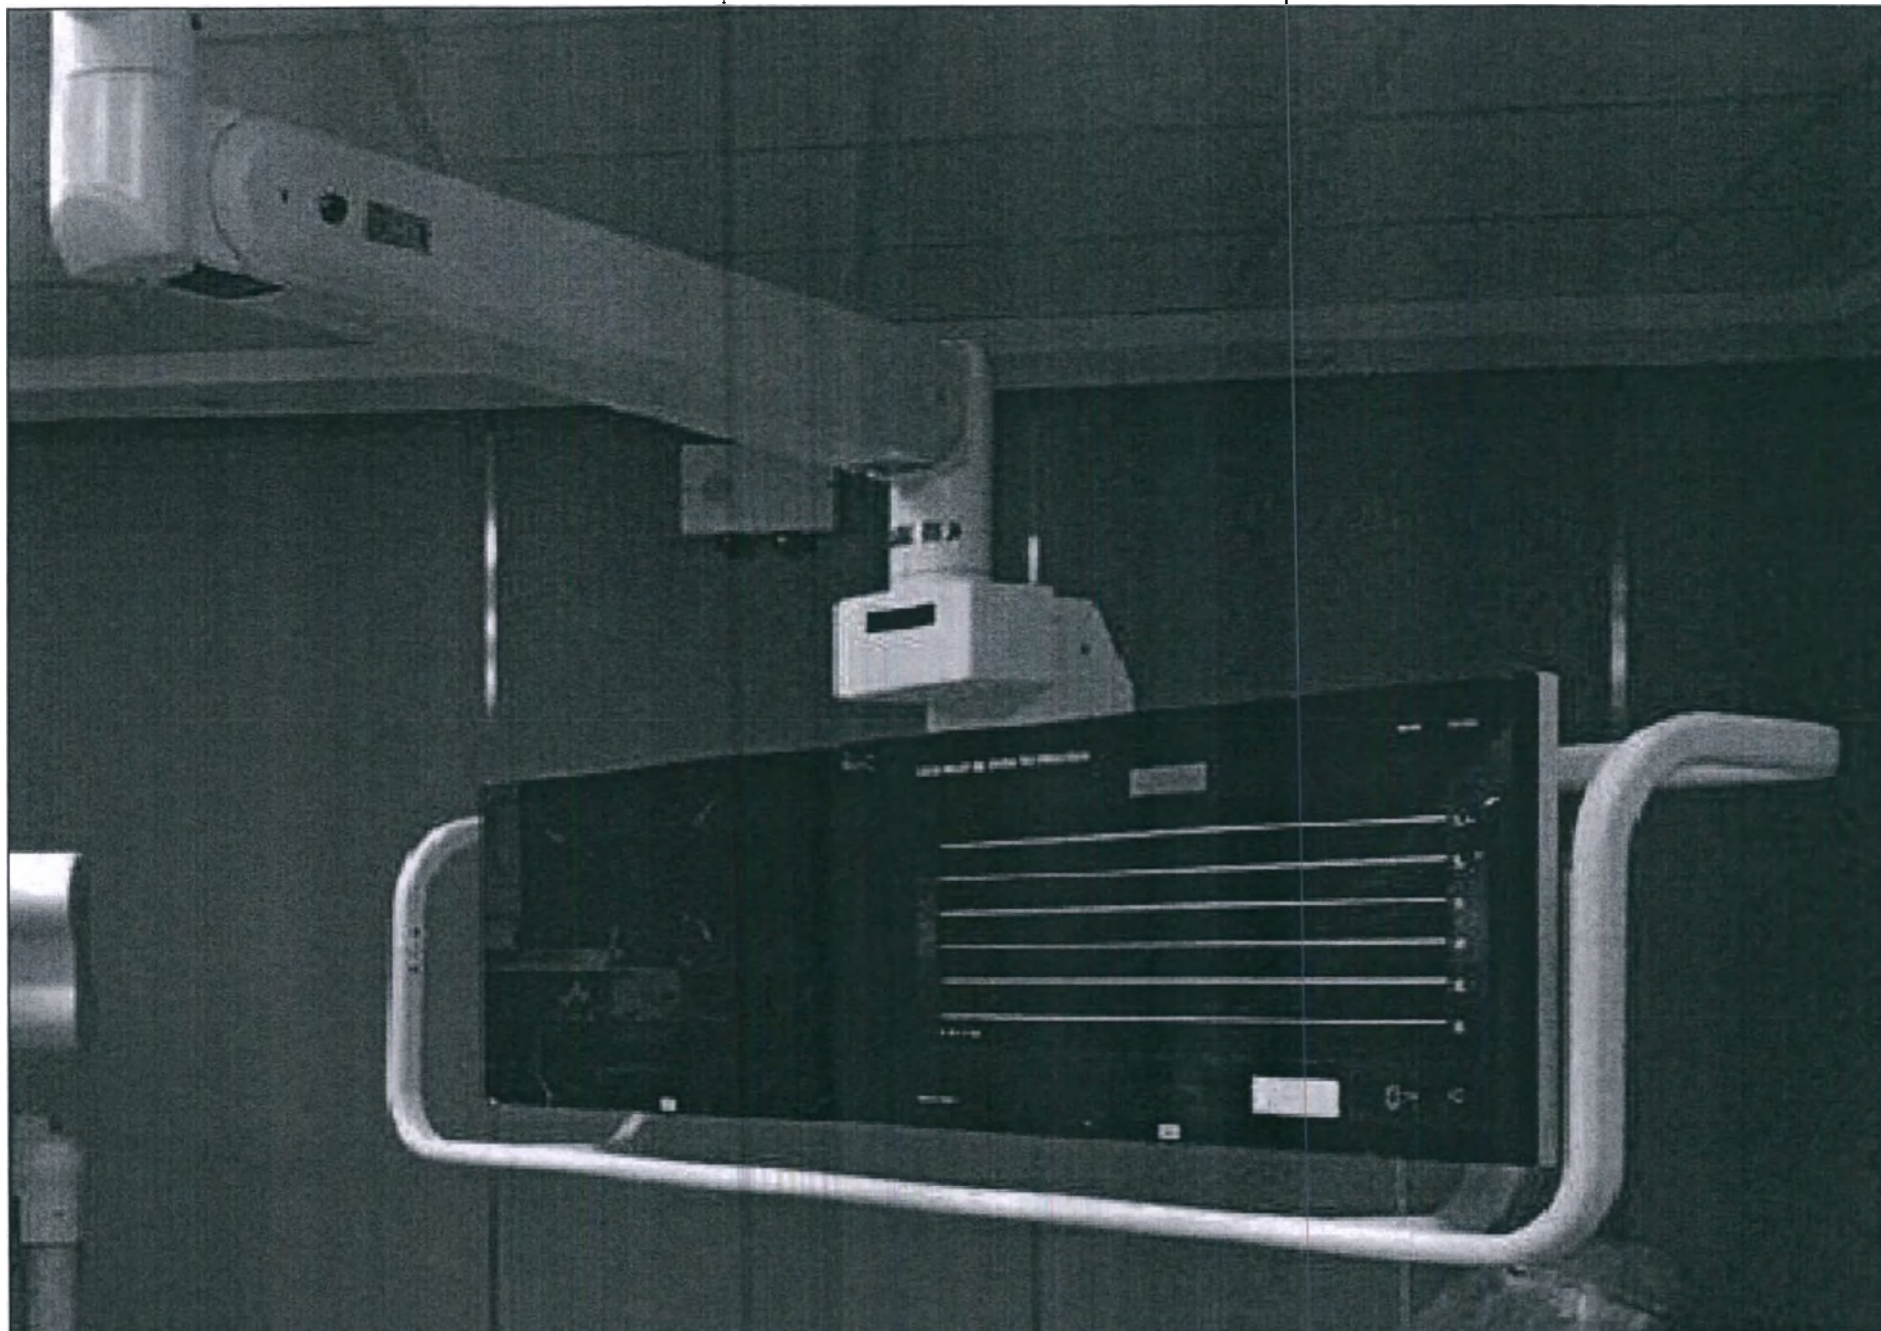


9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

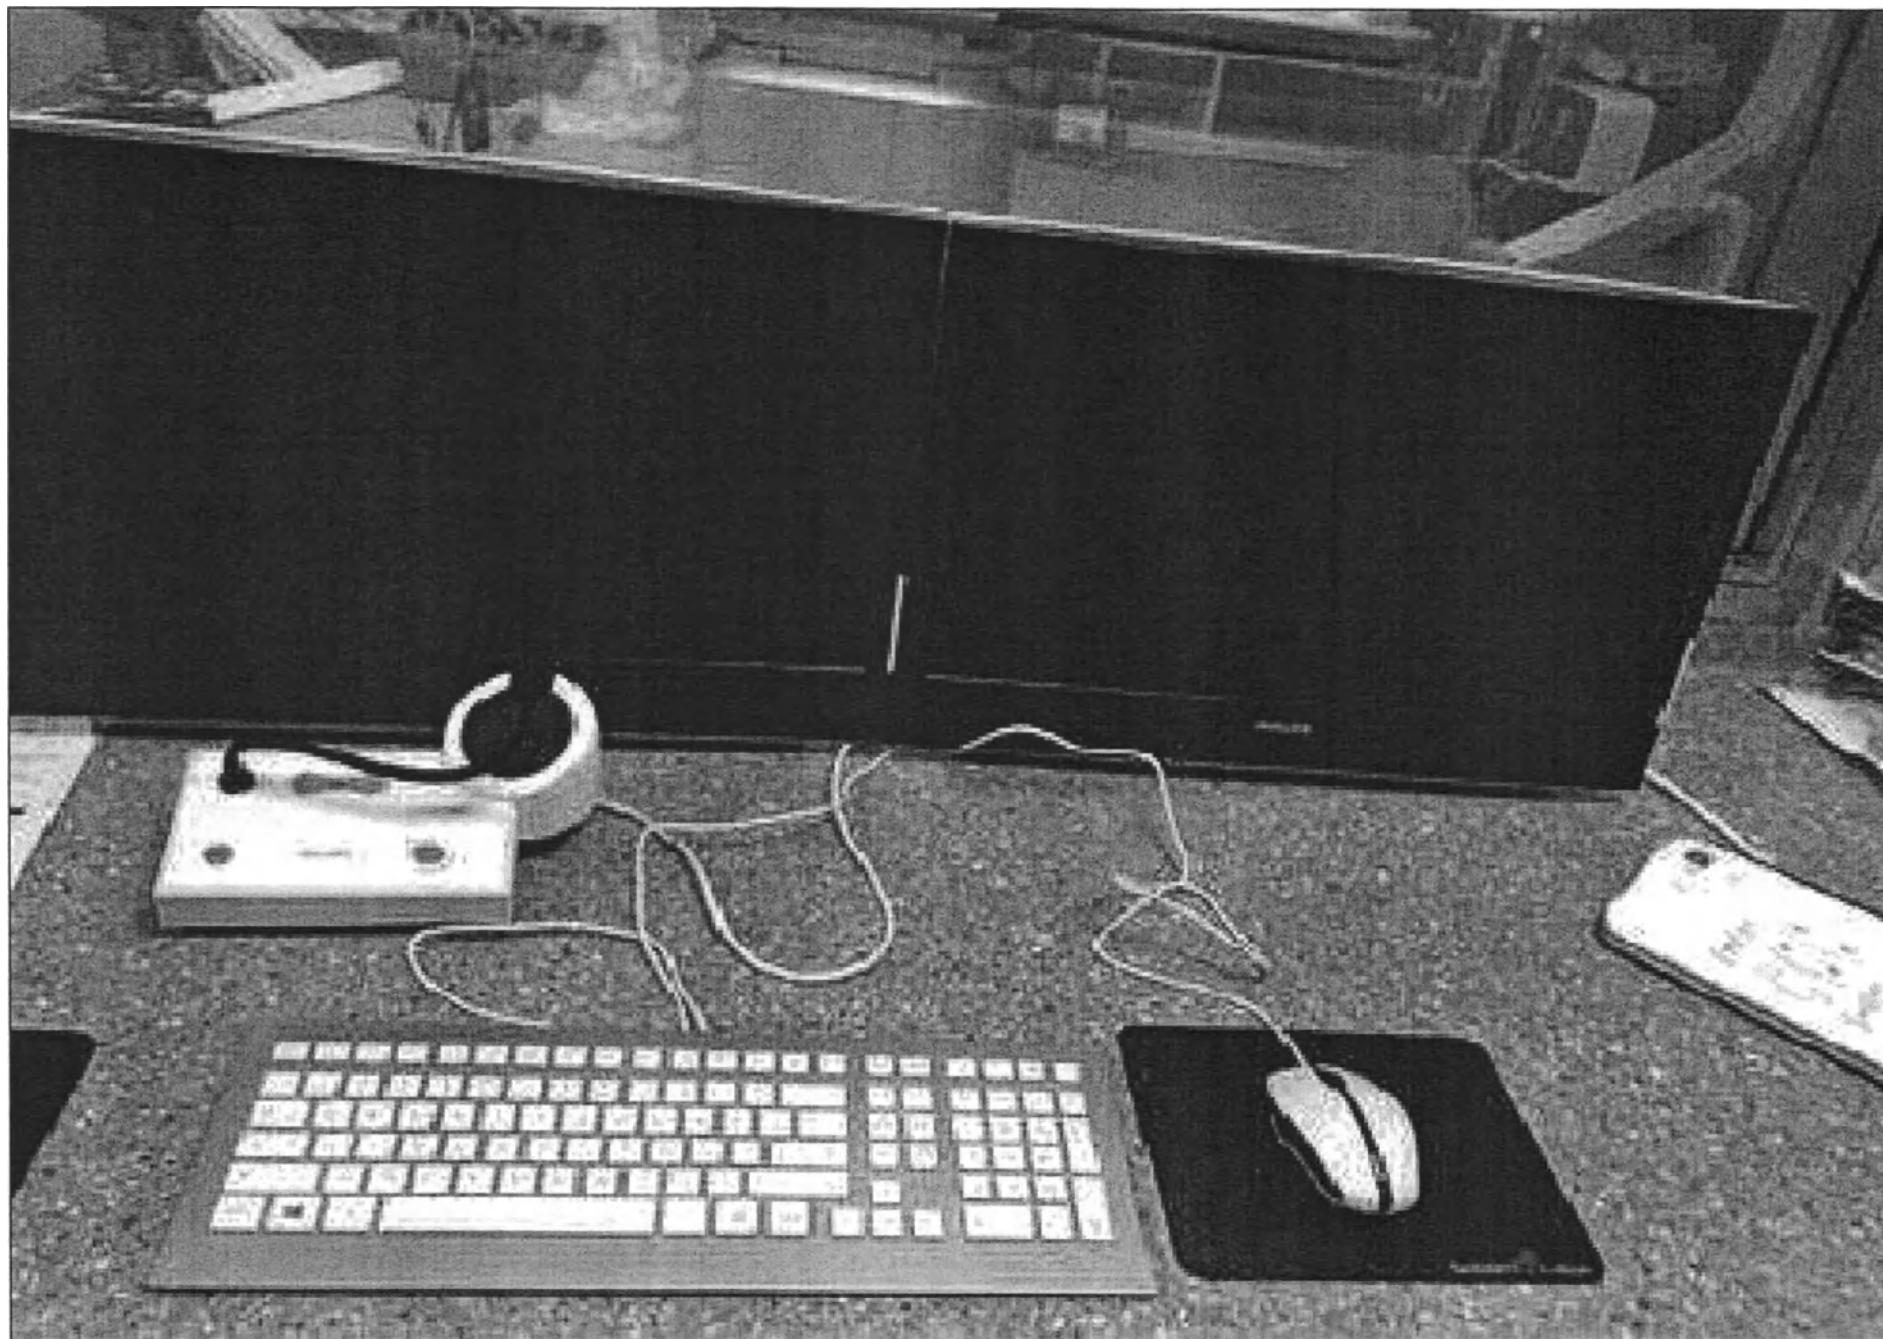


10.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.



10.6. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

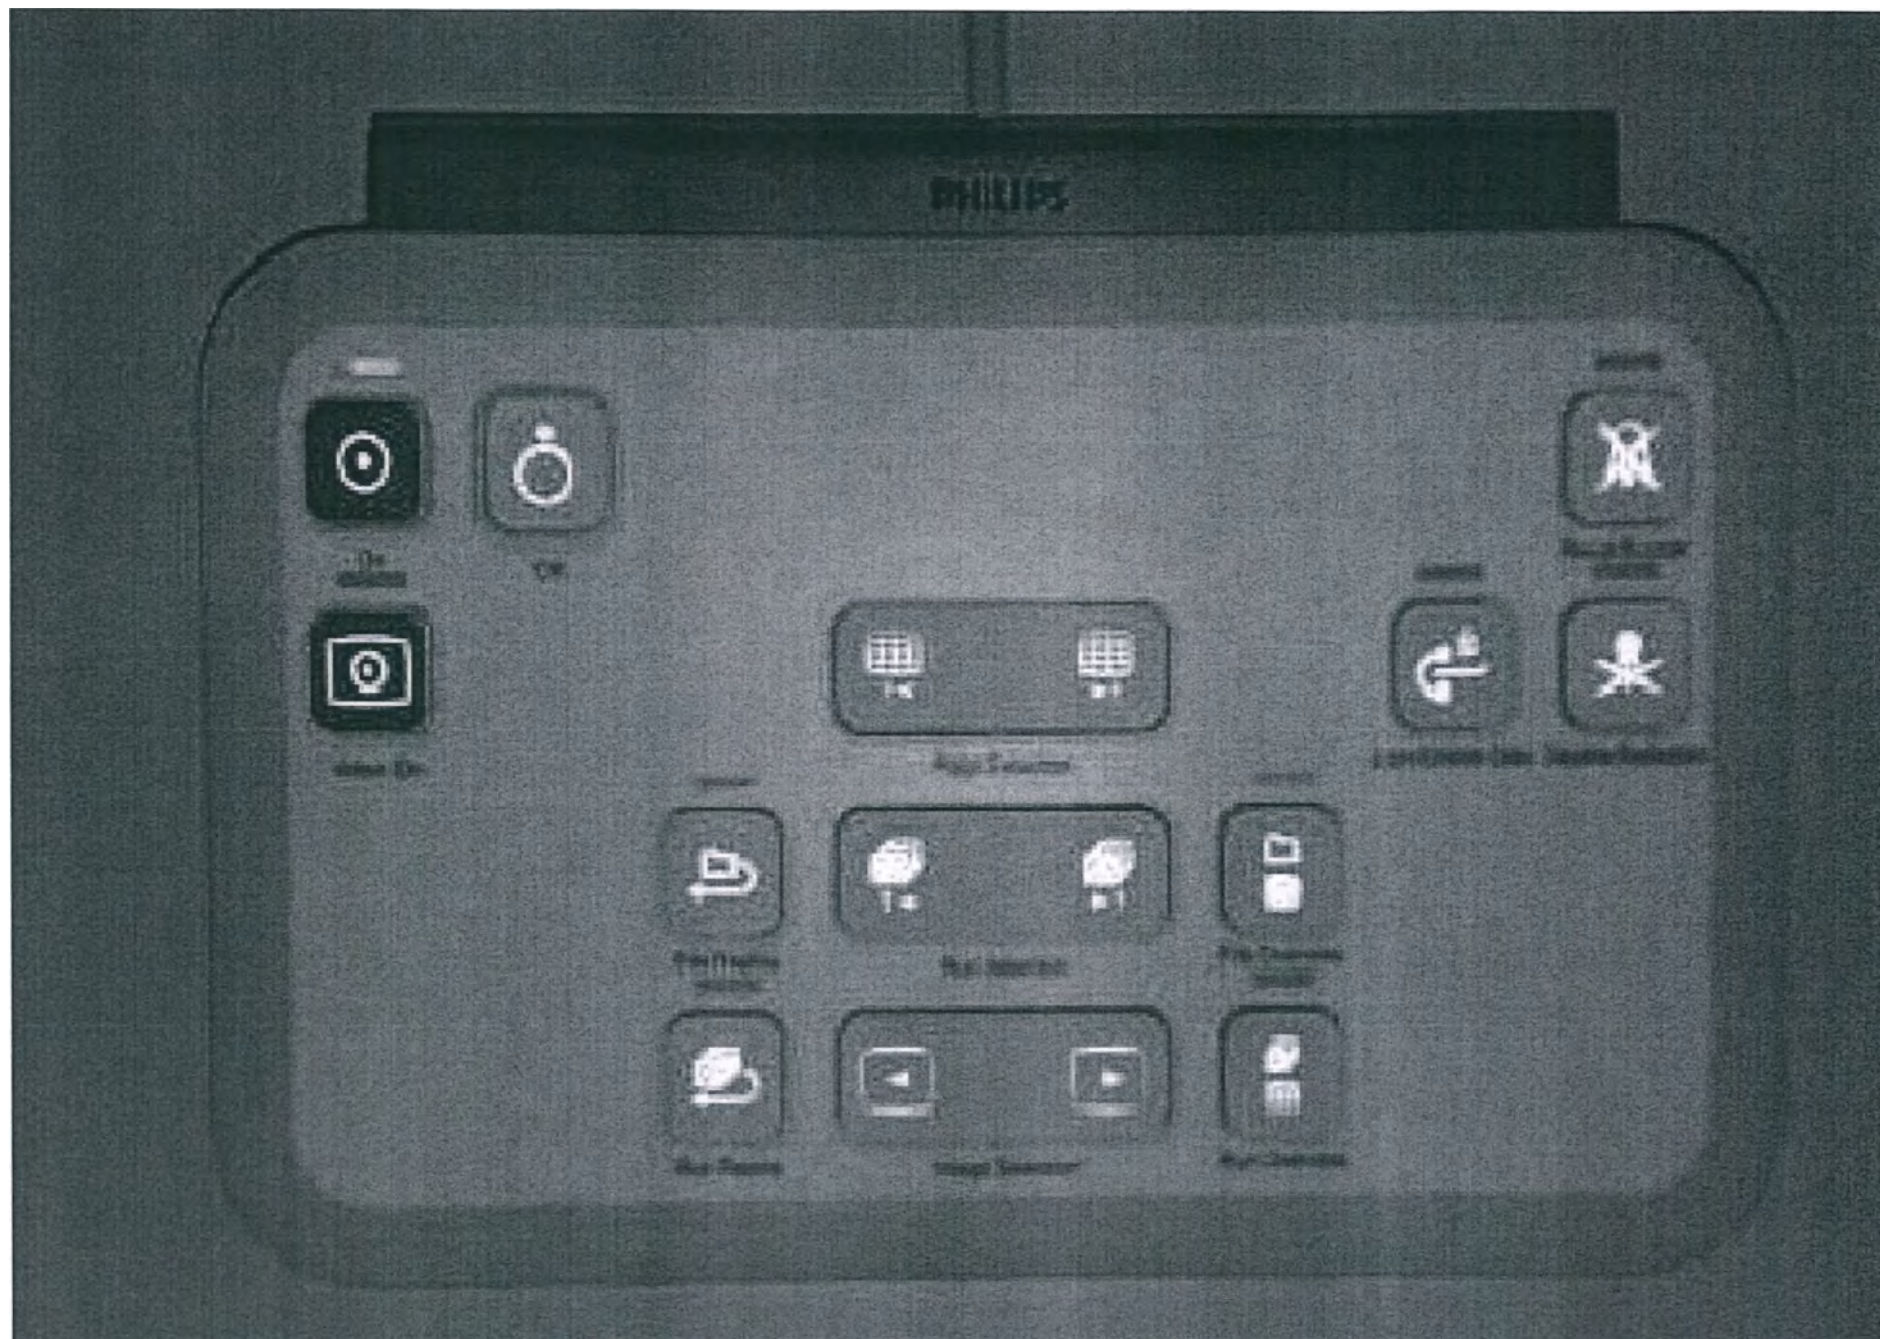


10.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

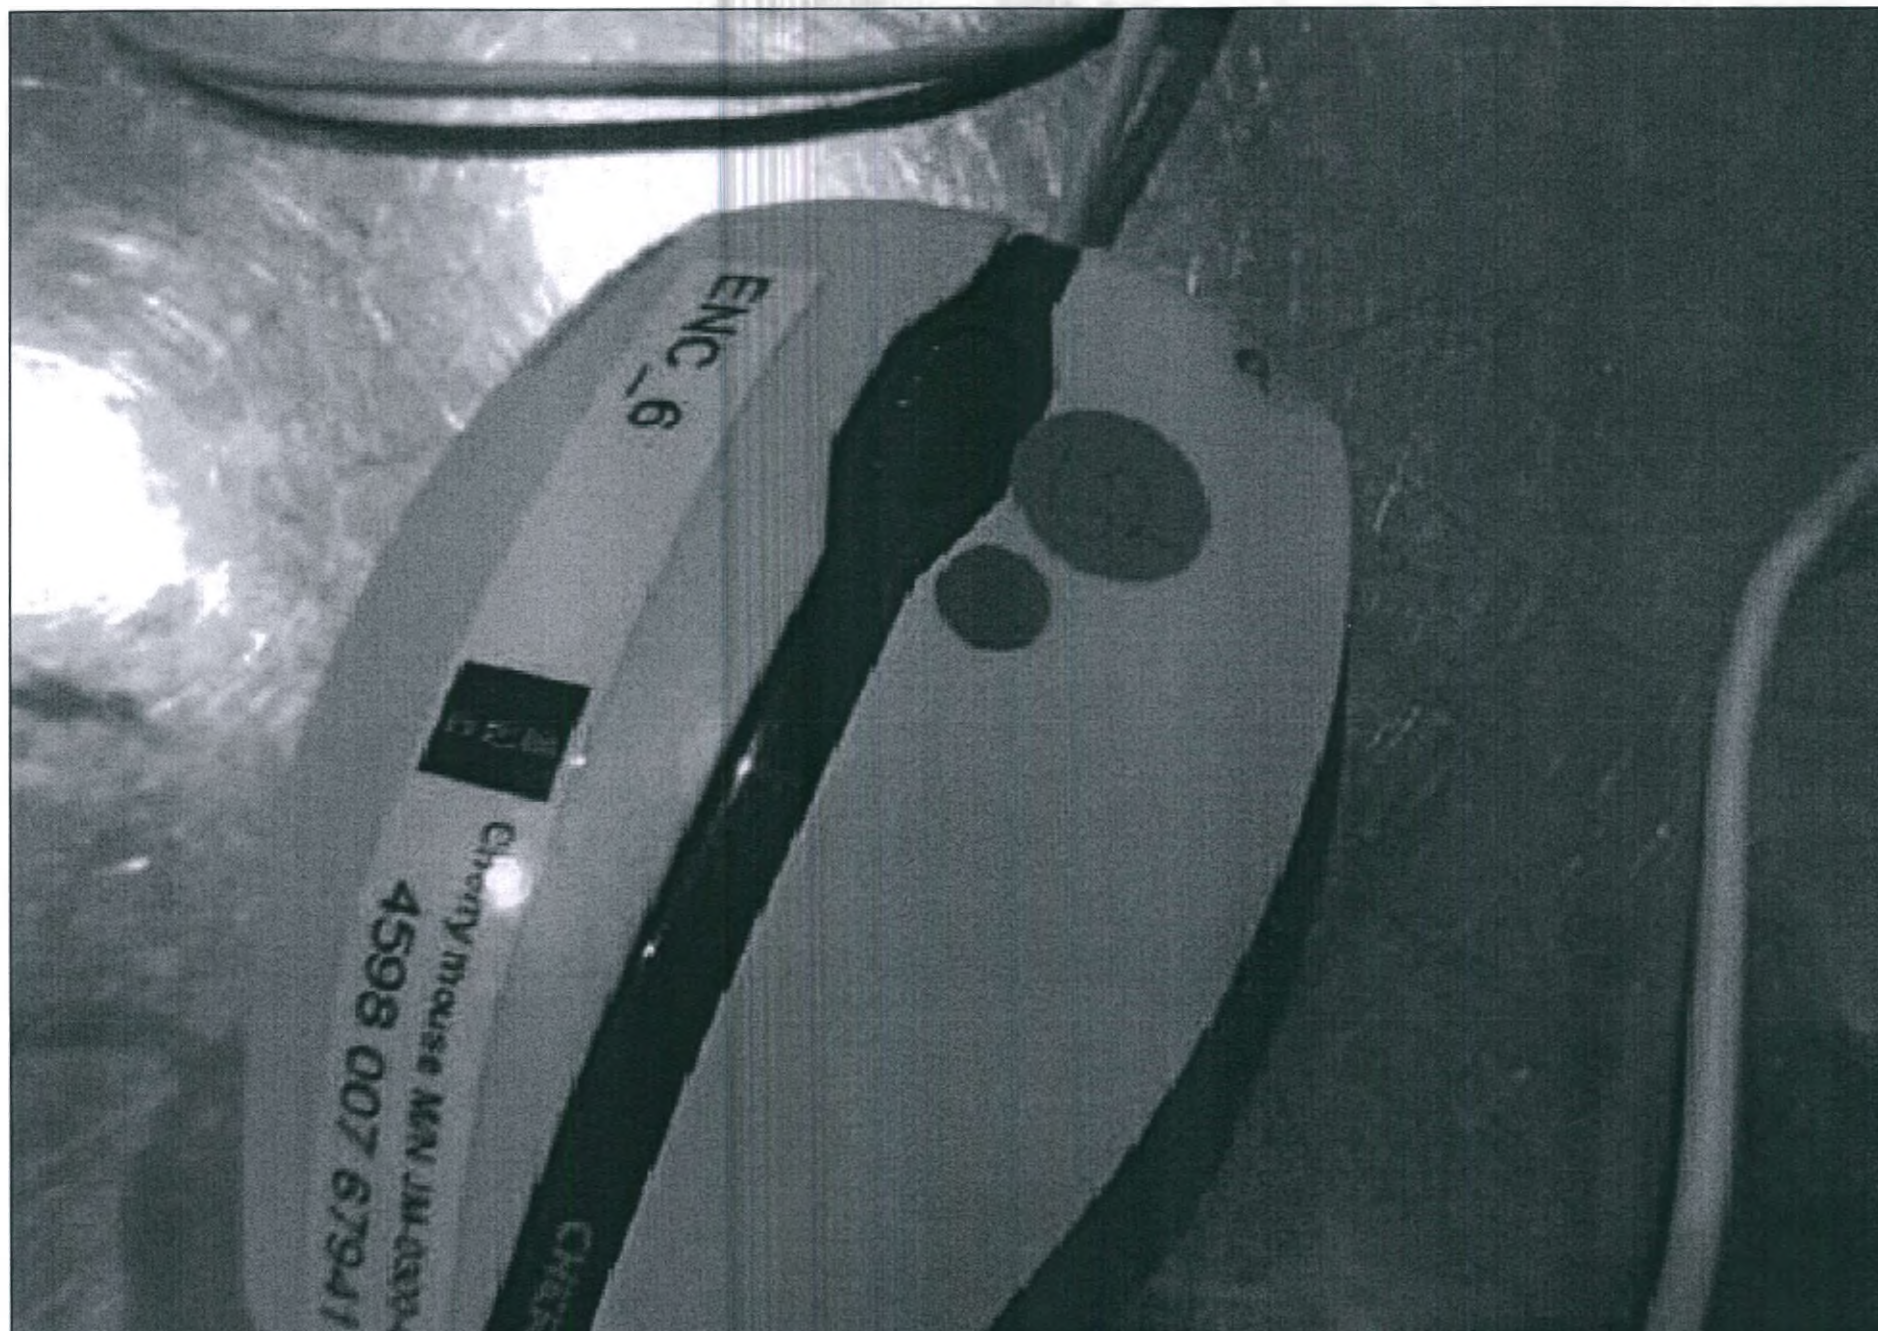


10.2. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.




10.д. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; **Мышь**; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

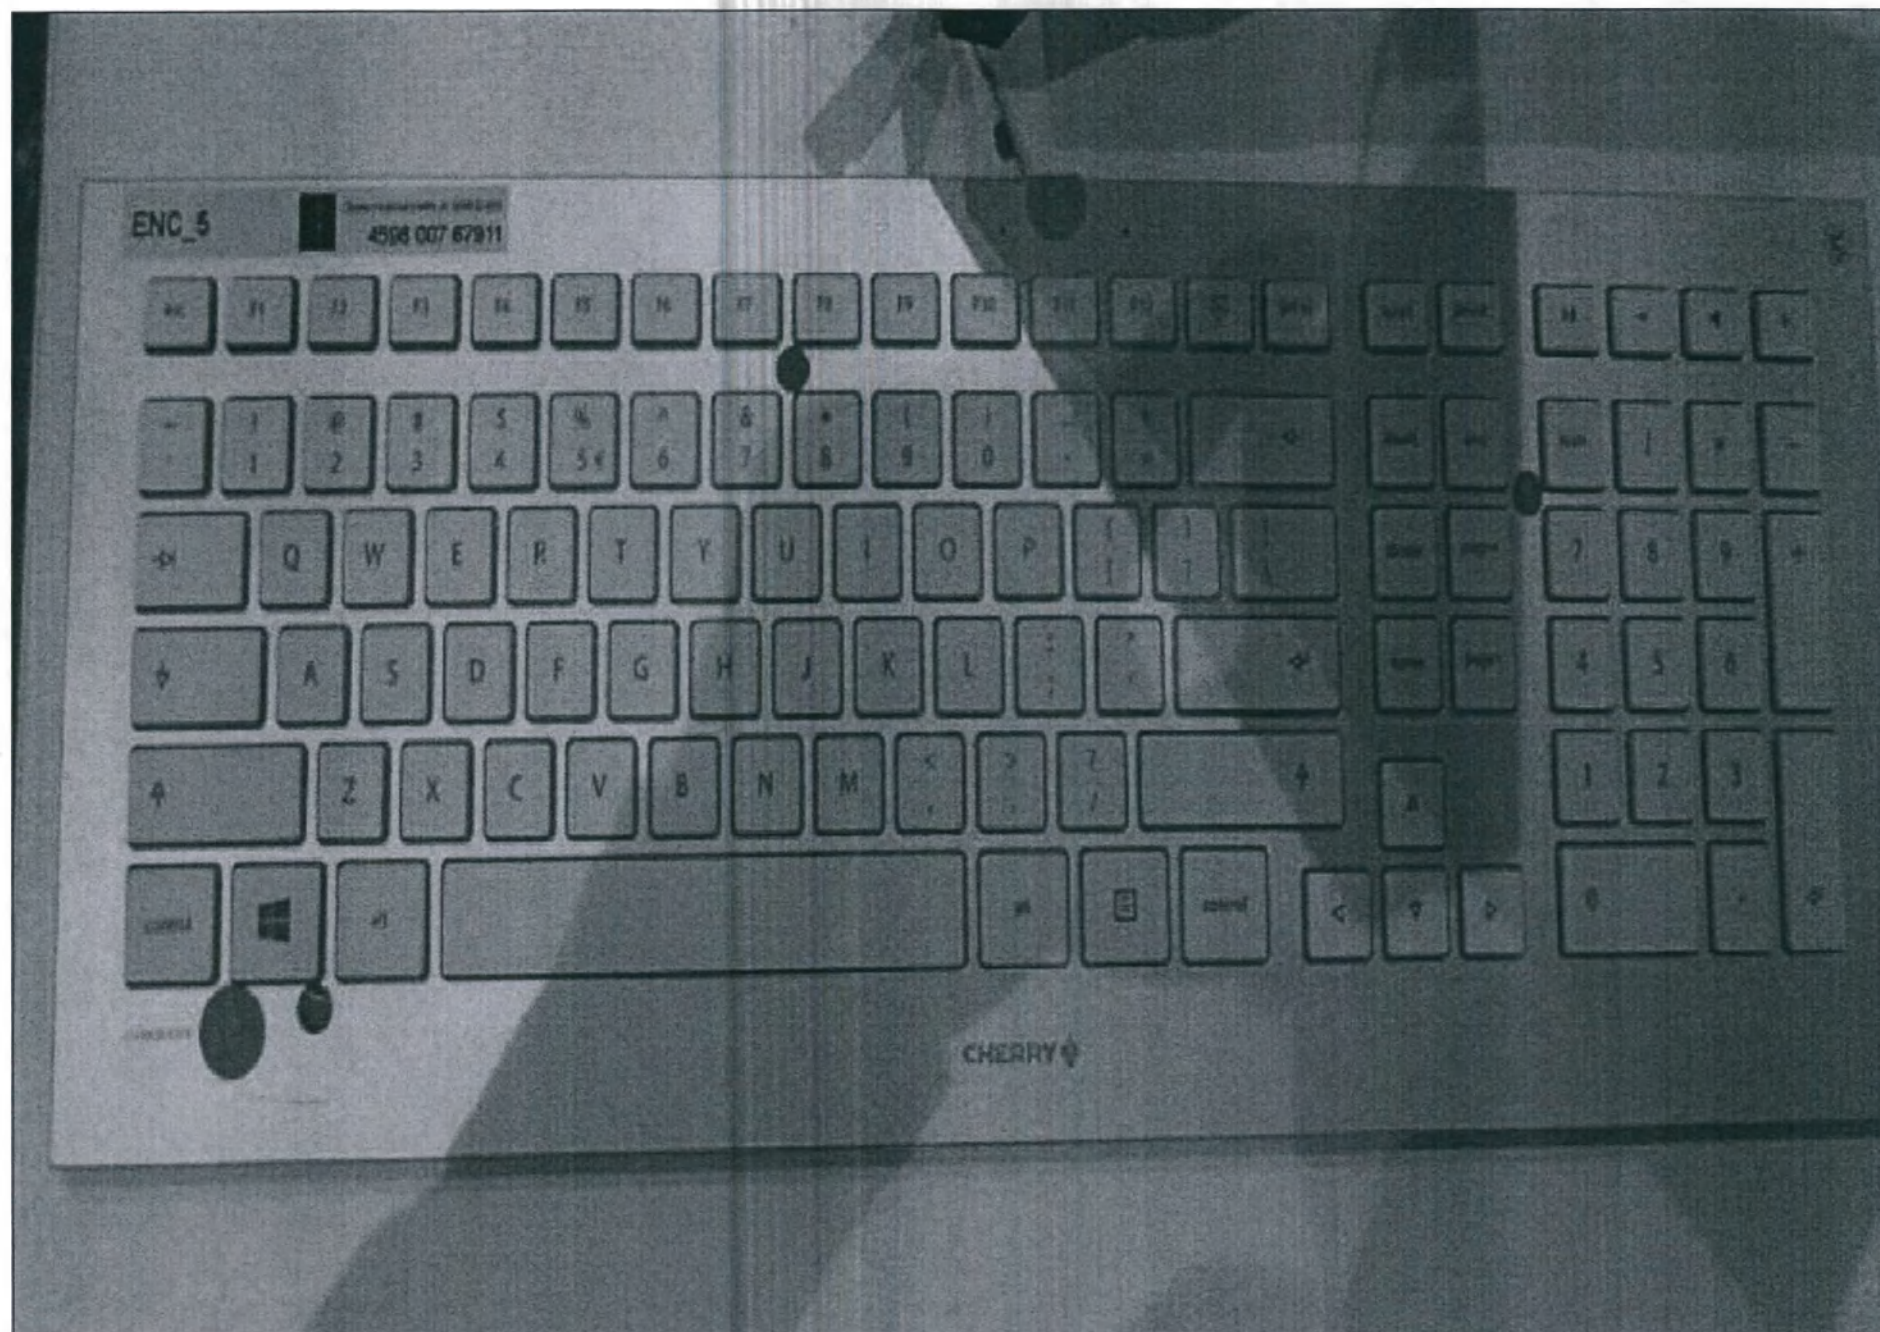


10.е. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

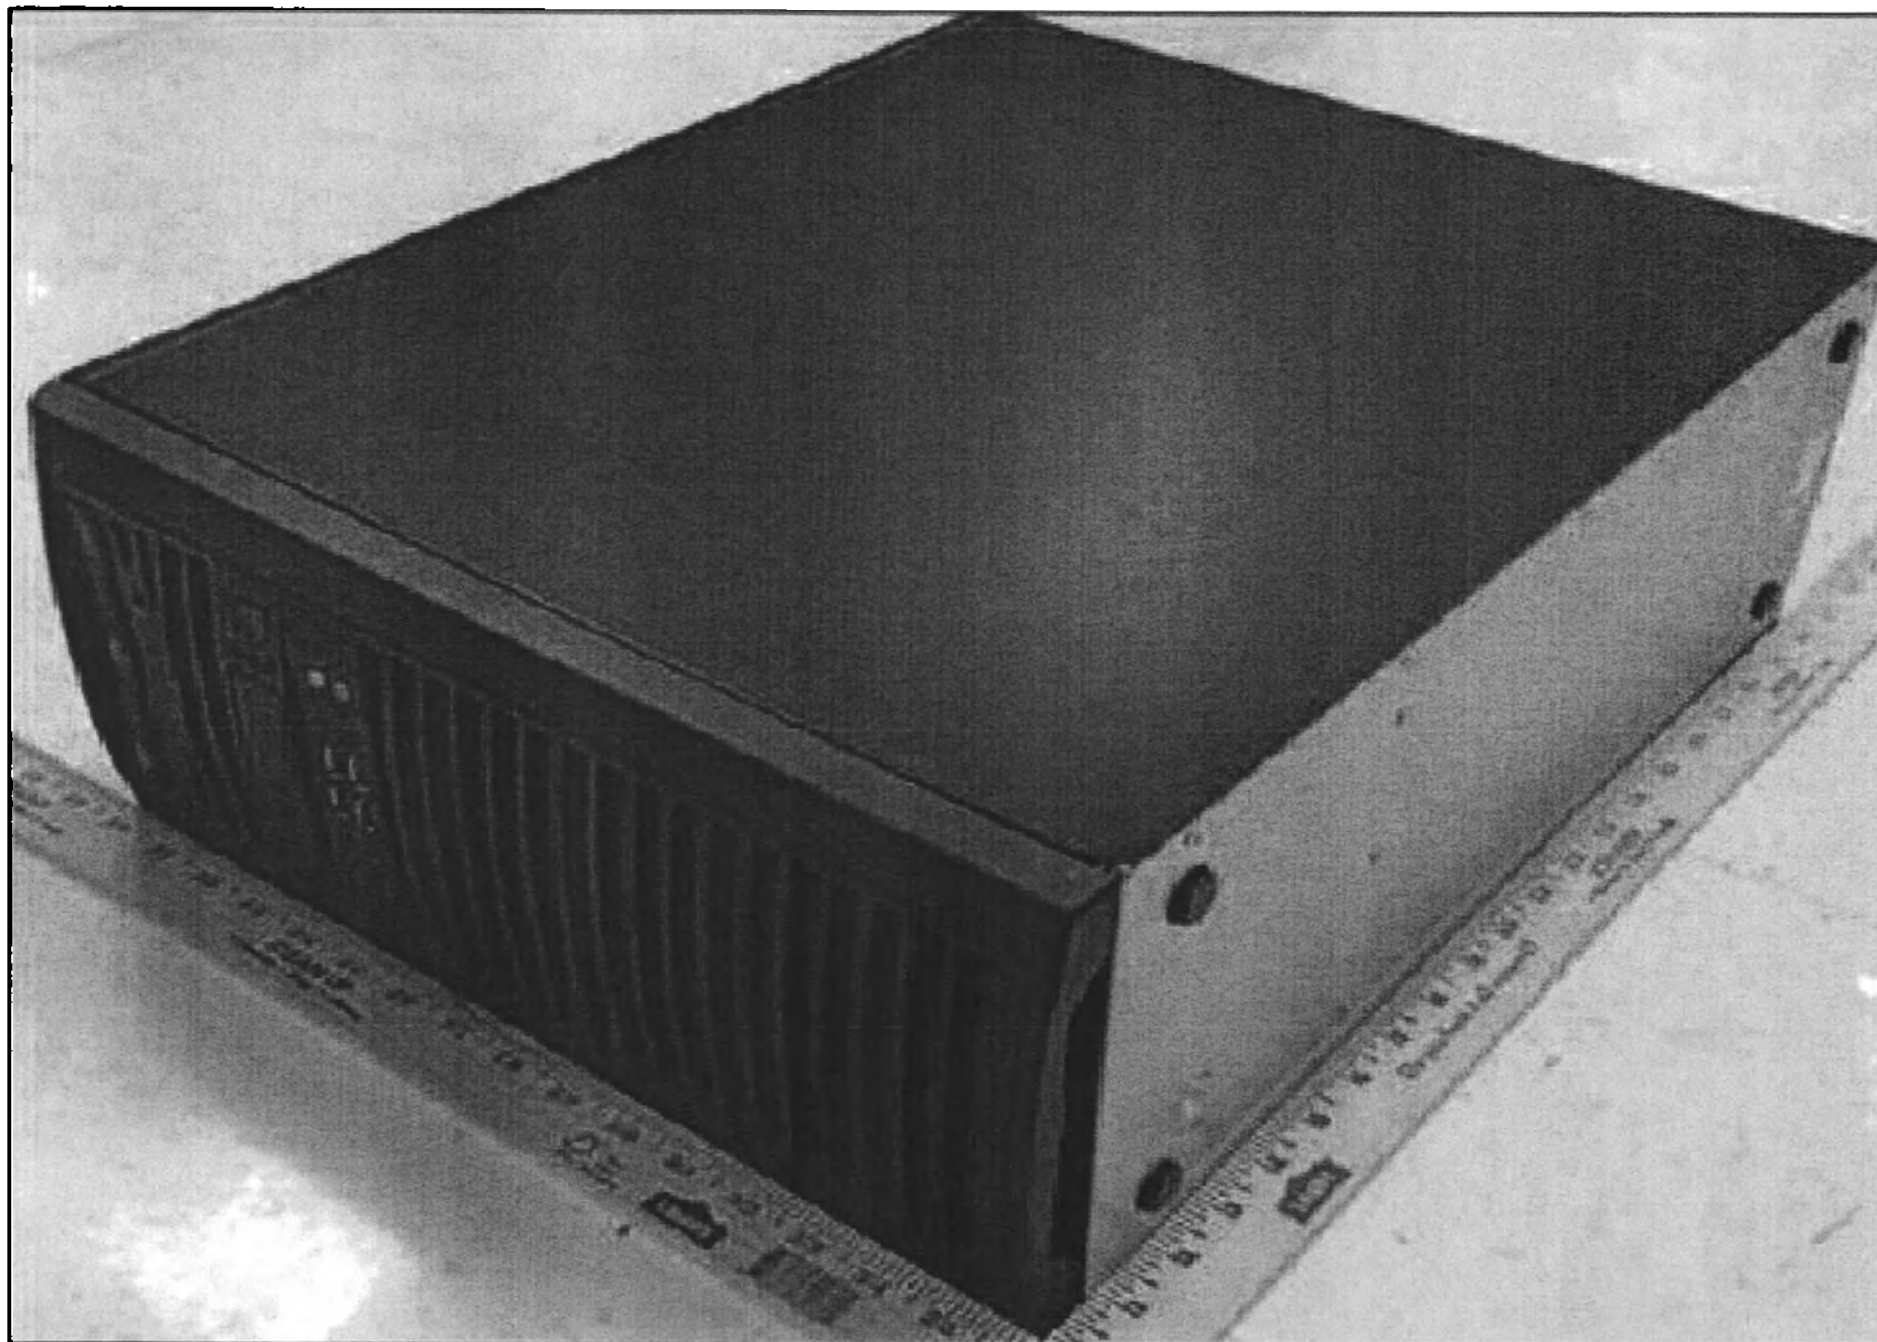

10.ж. Оборудование пультавой в составе: Мониторы цветные для пультавой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azigion версия 2.1 и выше.

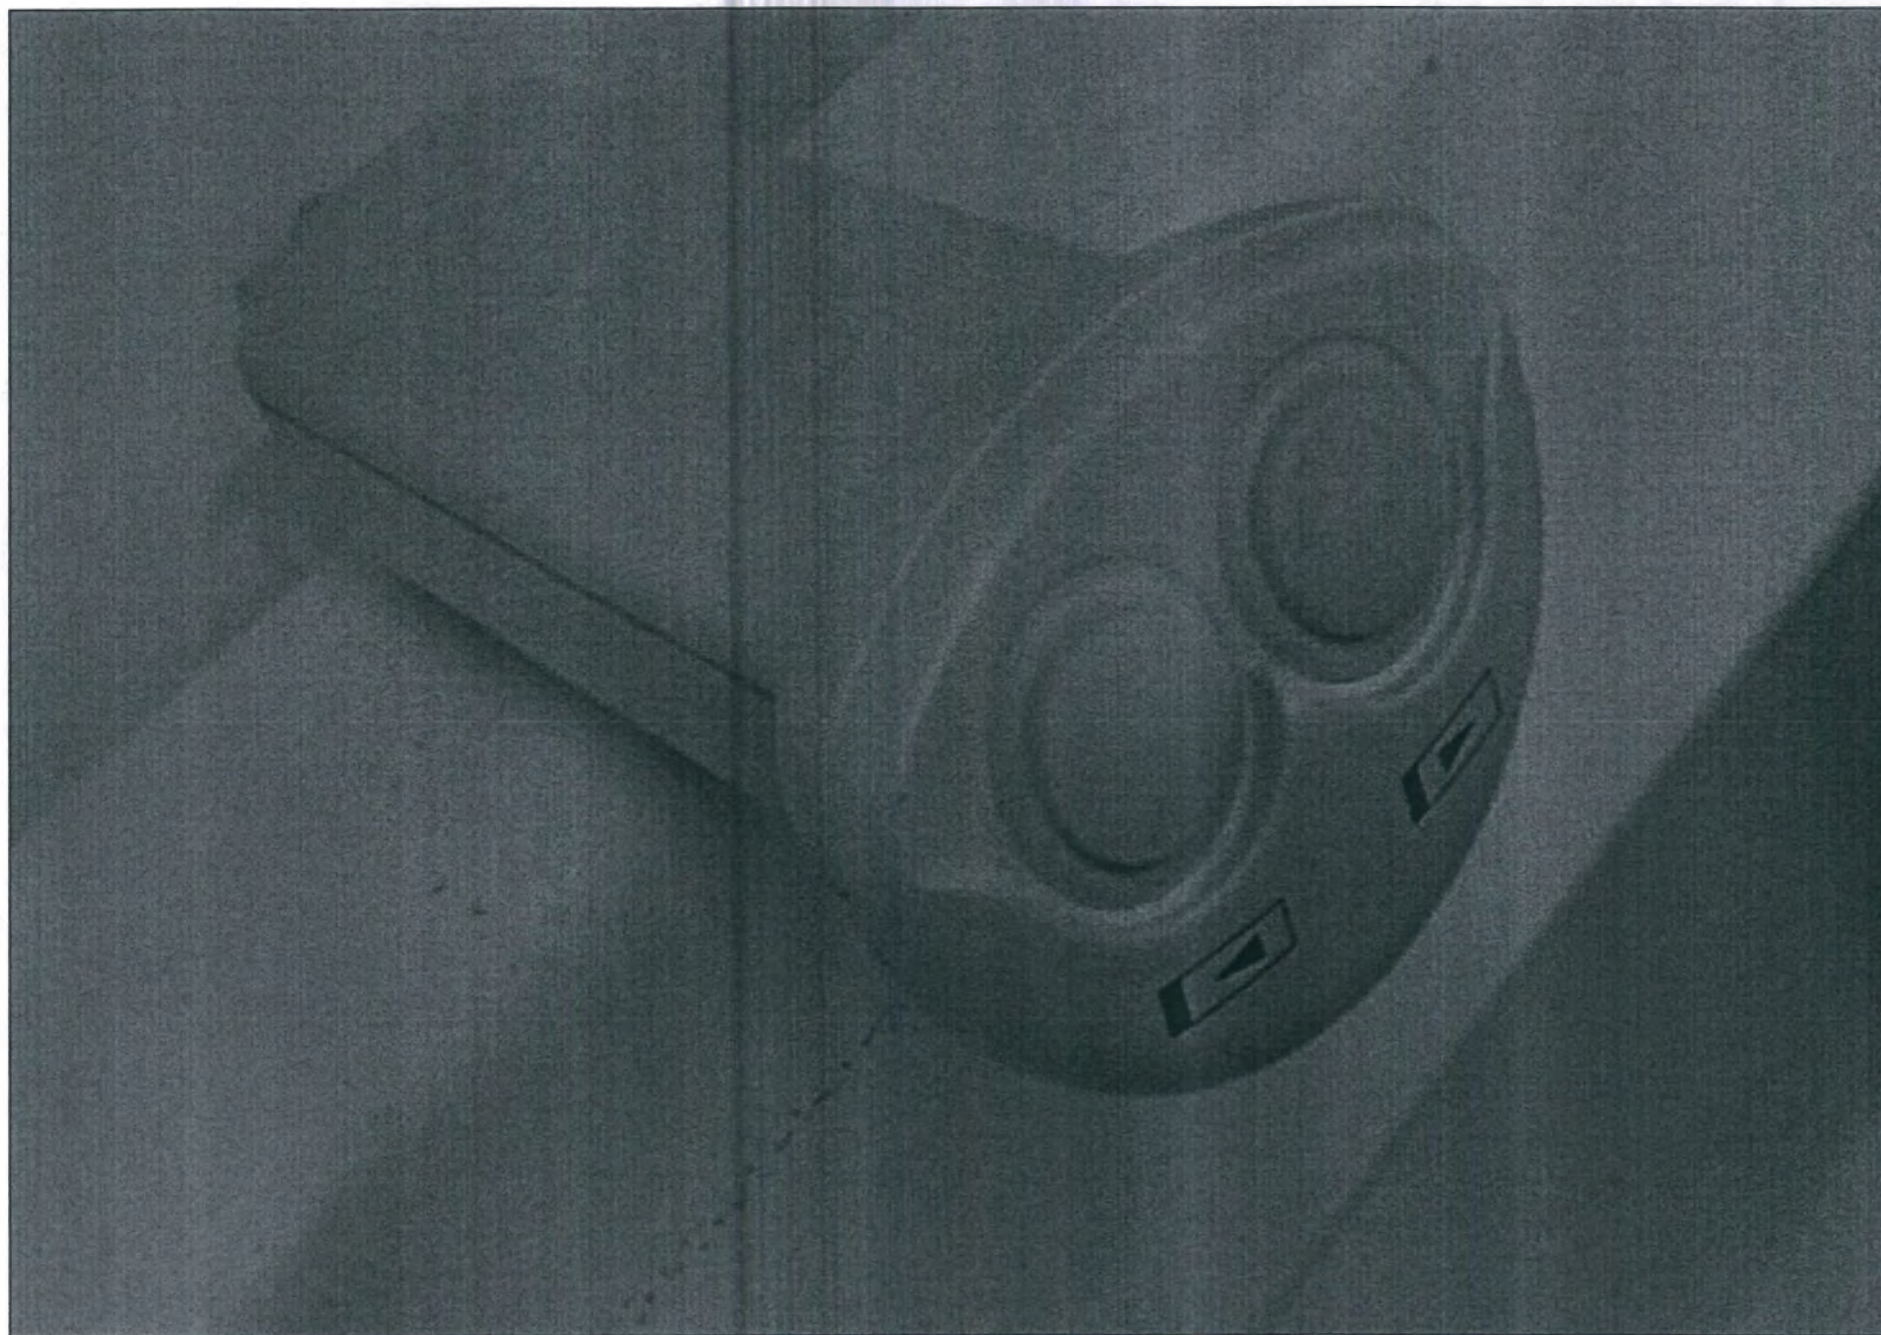


11. Ручной переключатель сдвига.

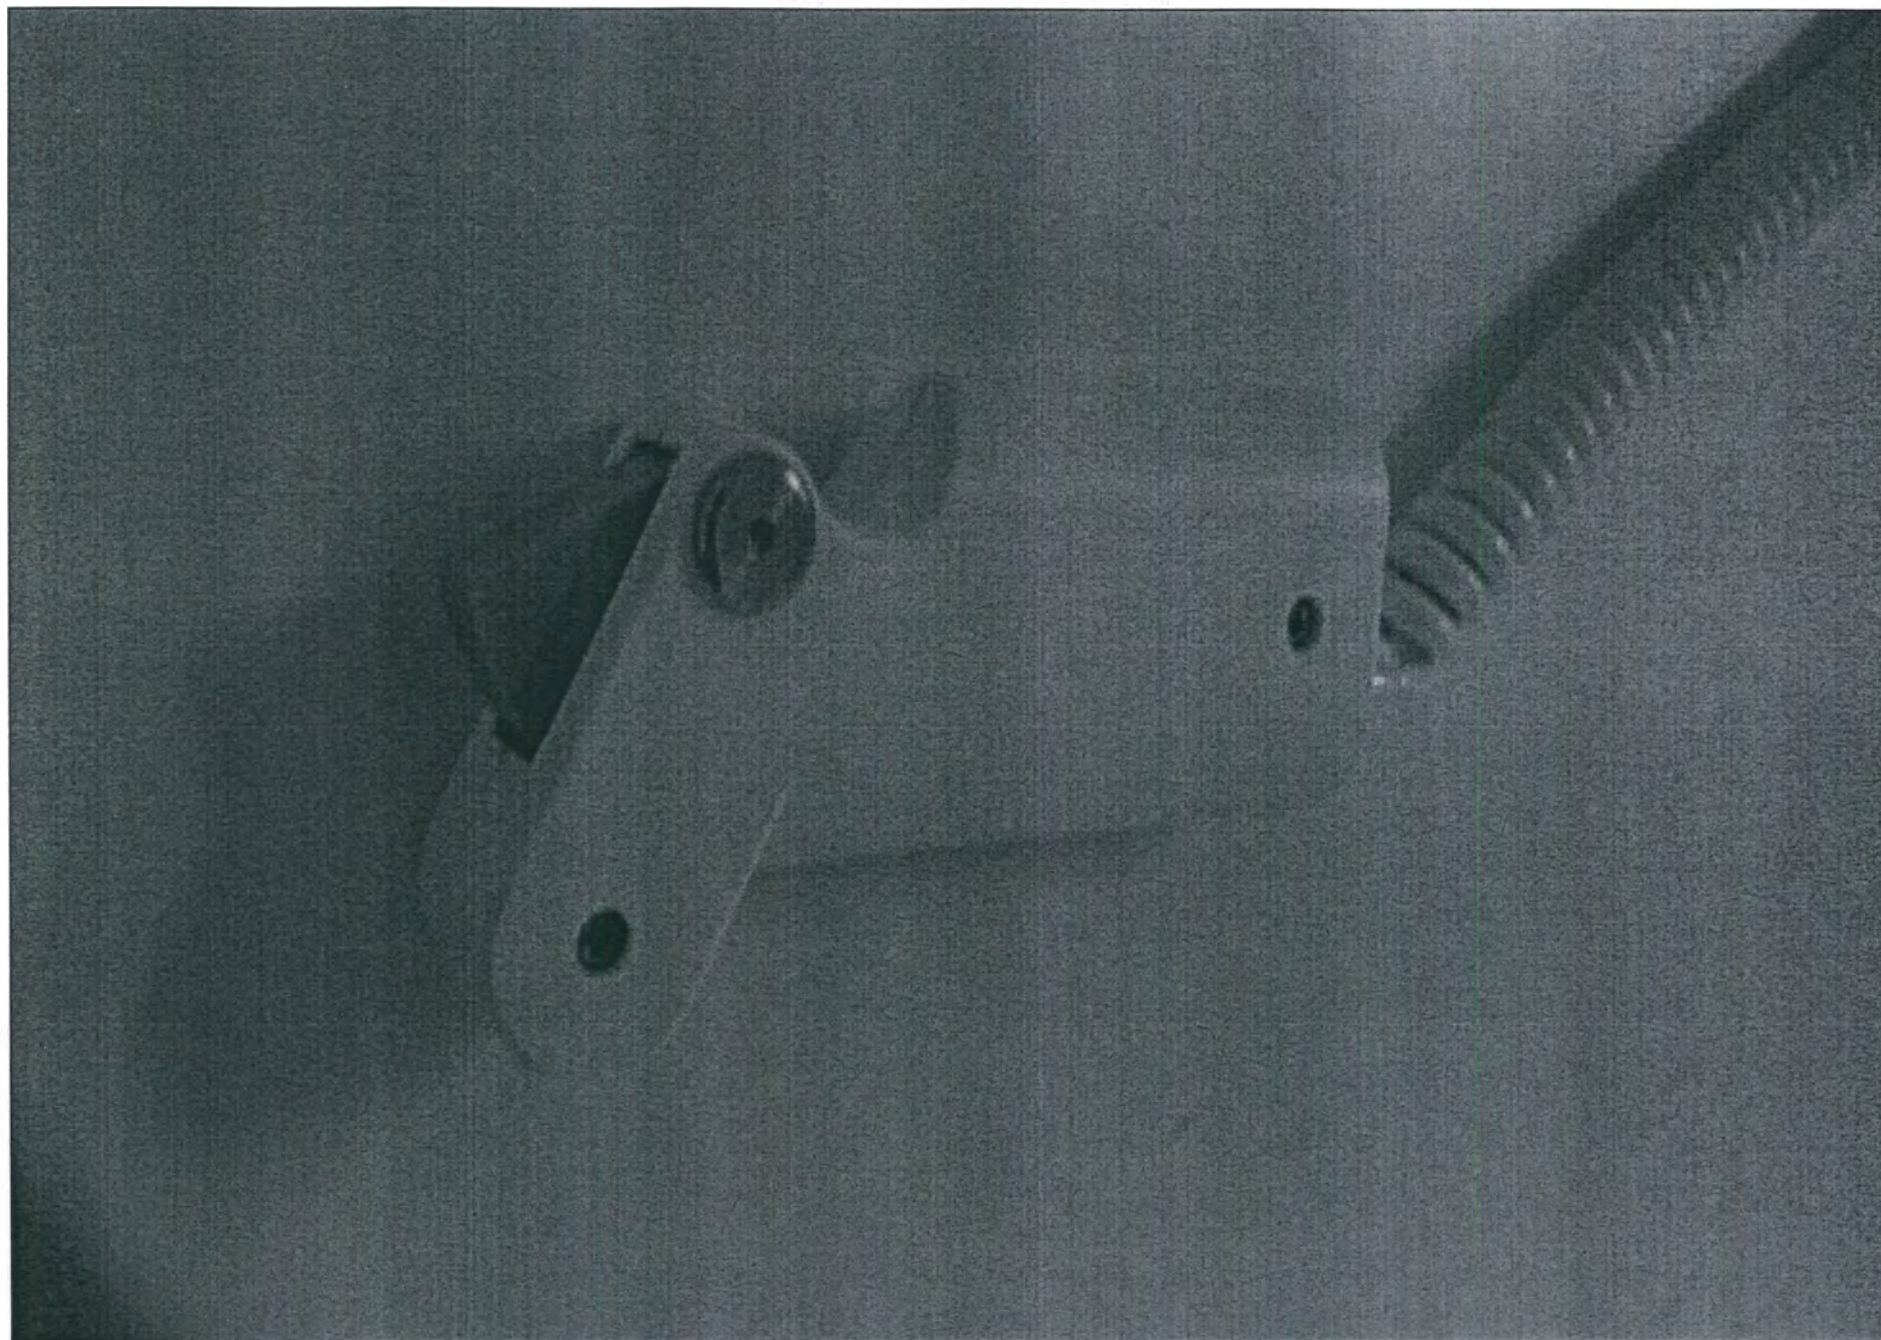


12. Регулятор скорости.




13. Ручной переключатель экспозиции.

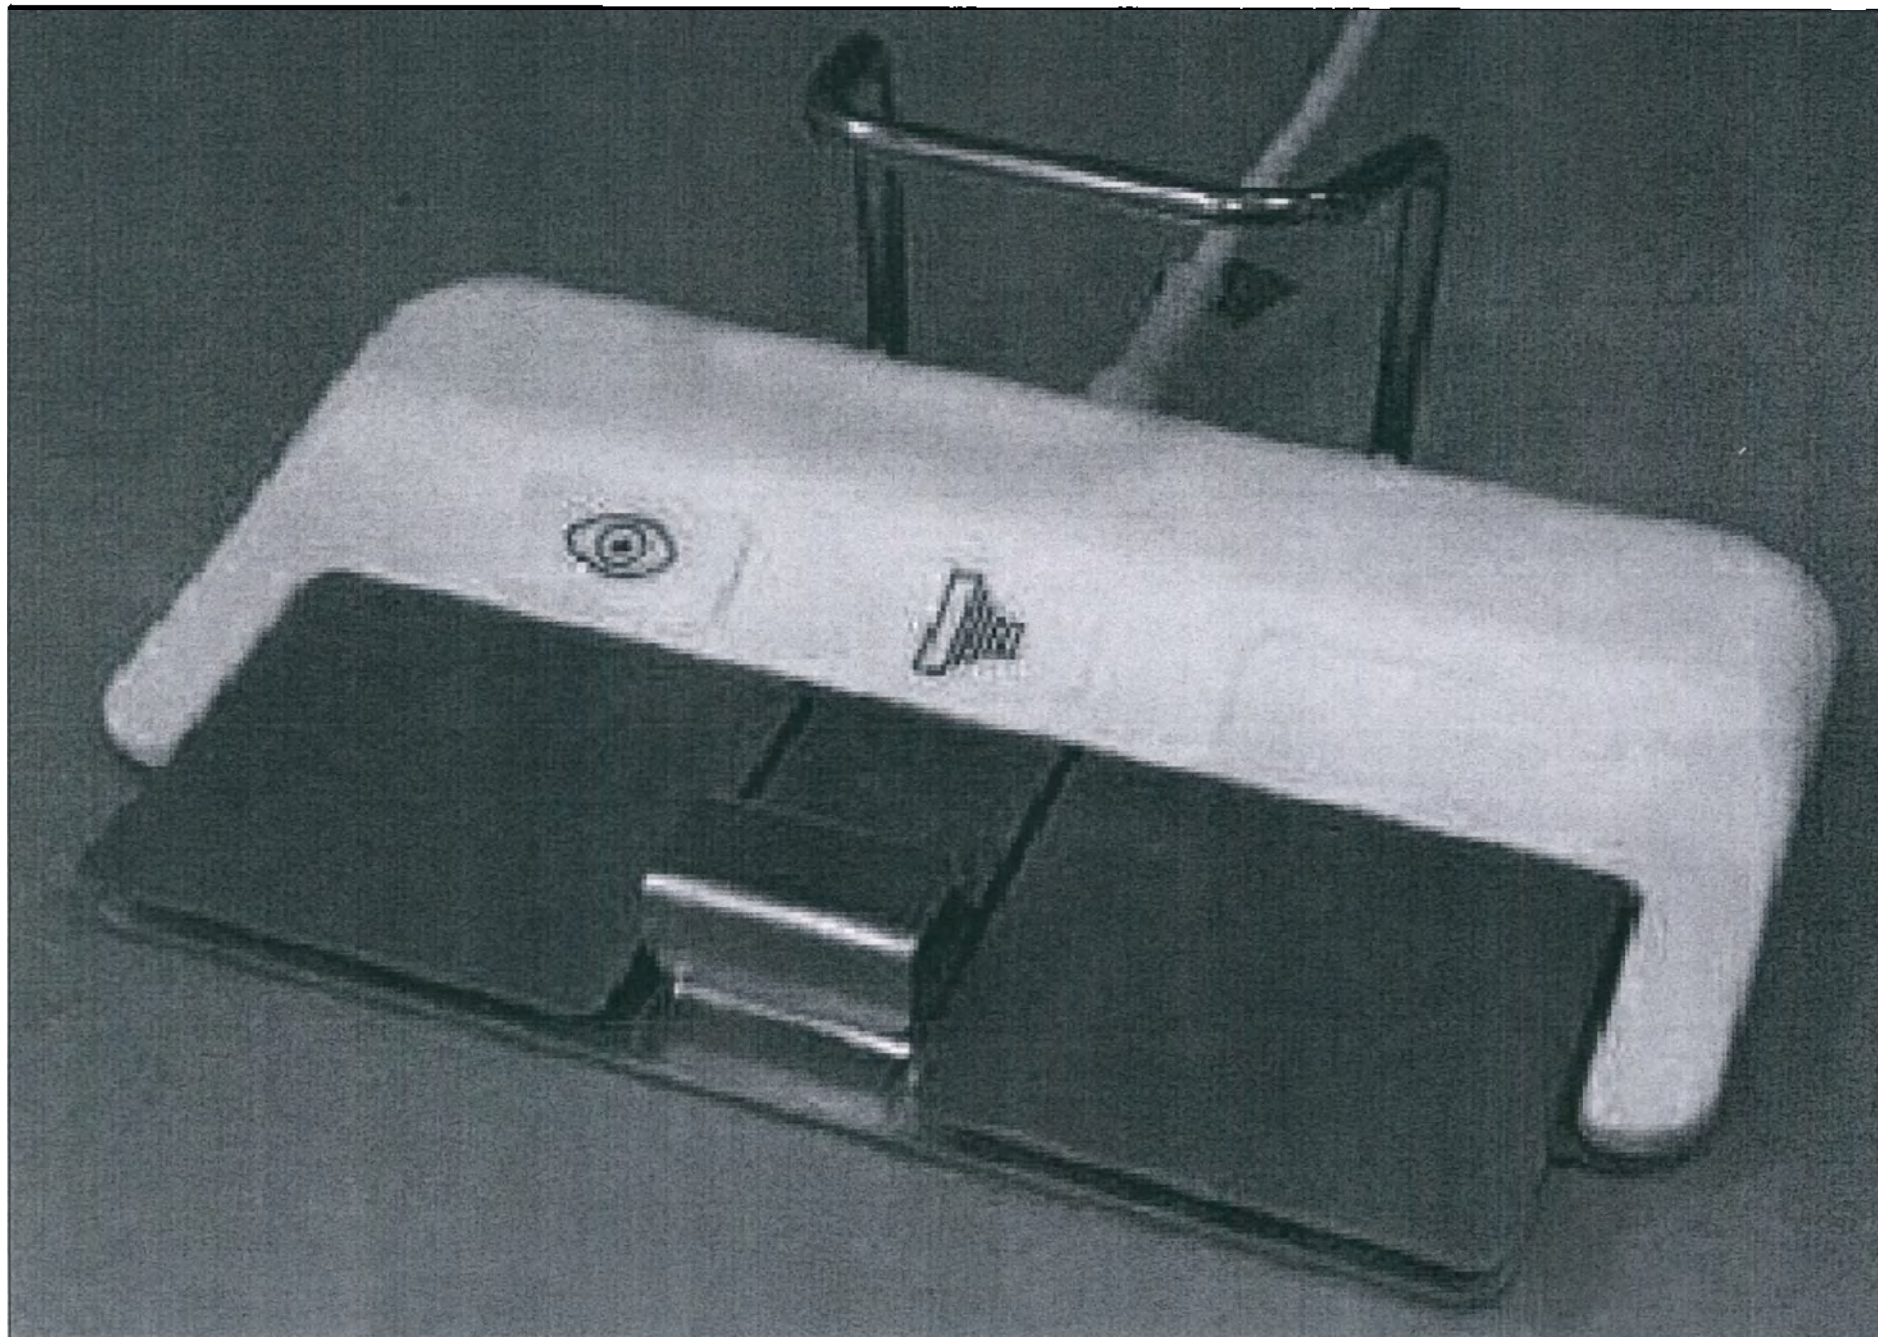


14. Ножной переключатель, не более 2 шт.

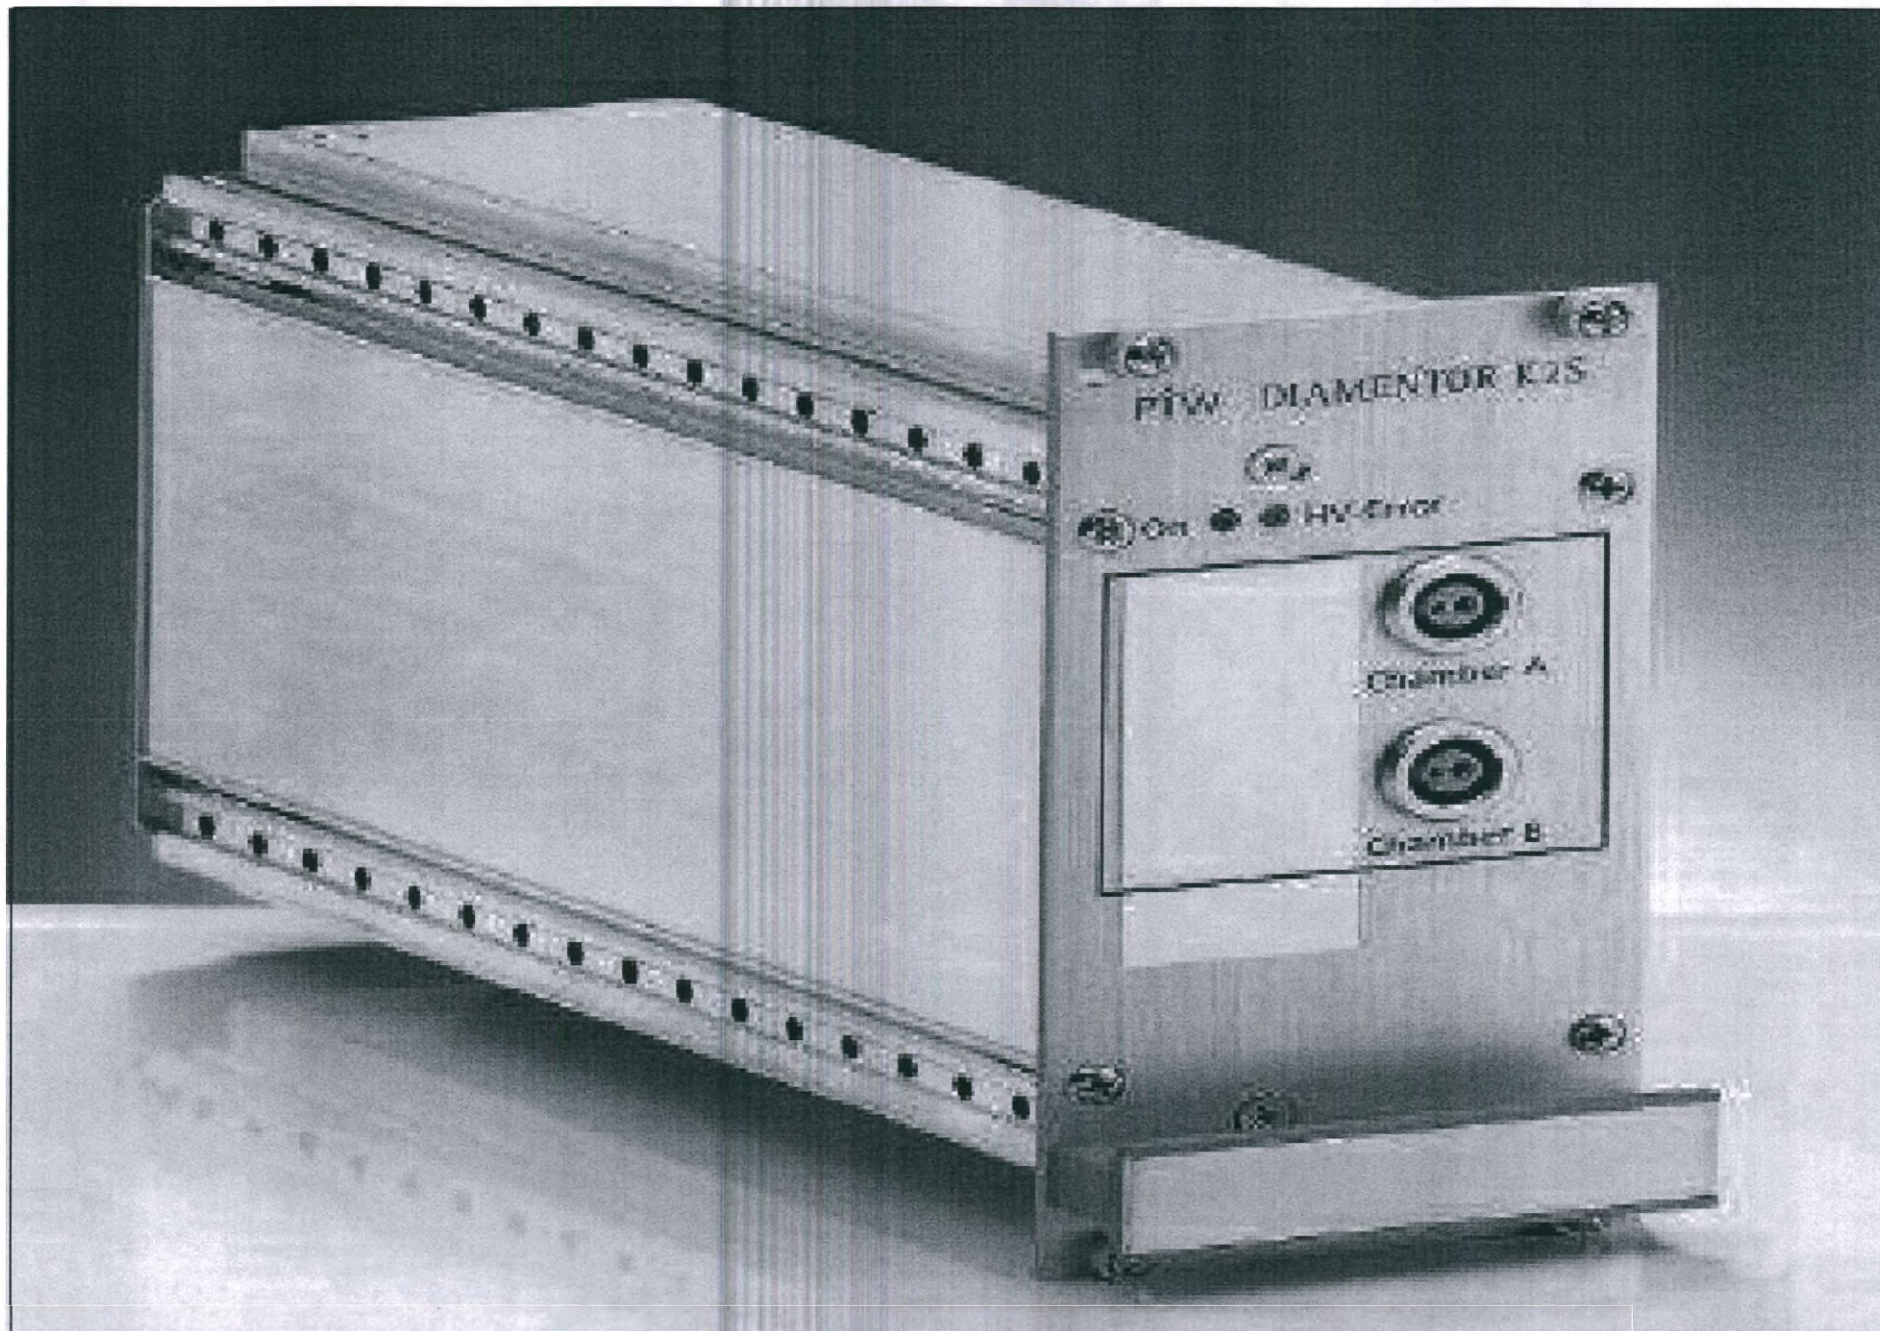


15.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

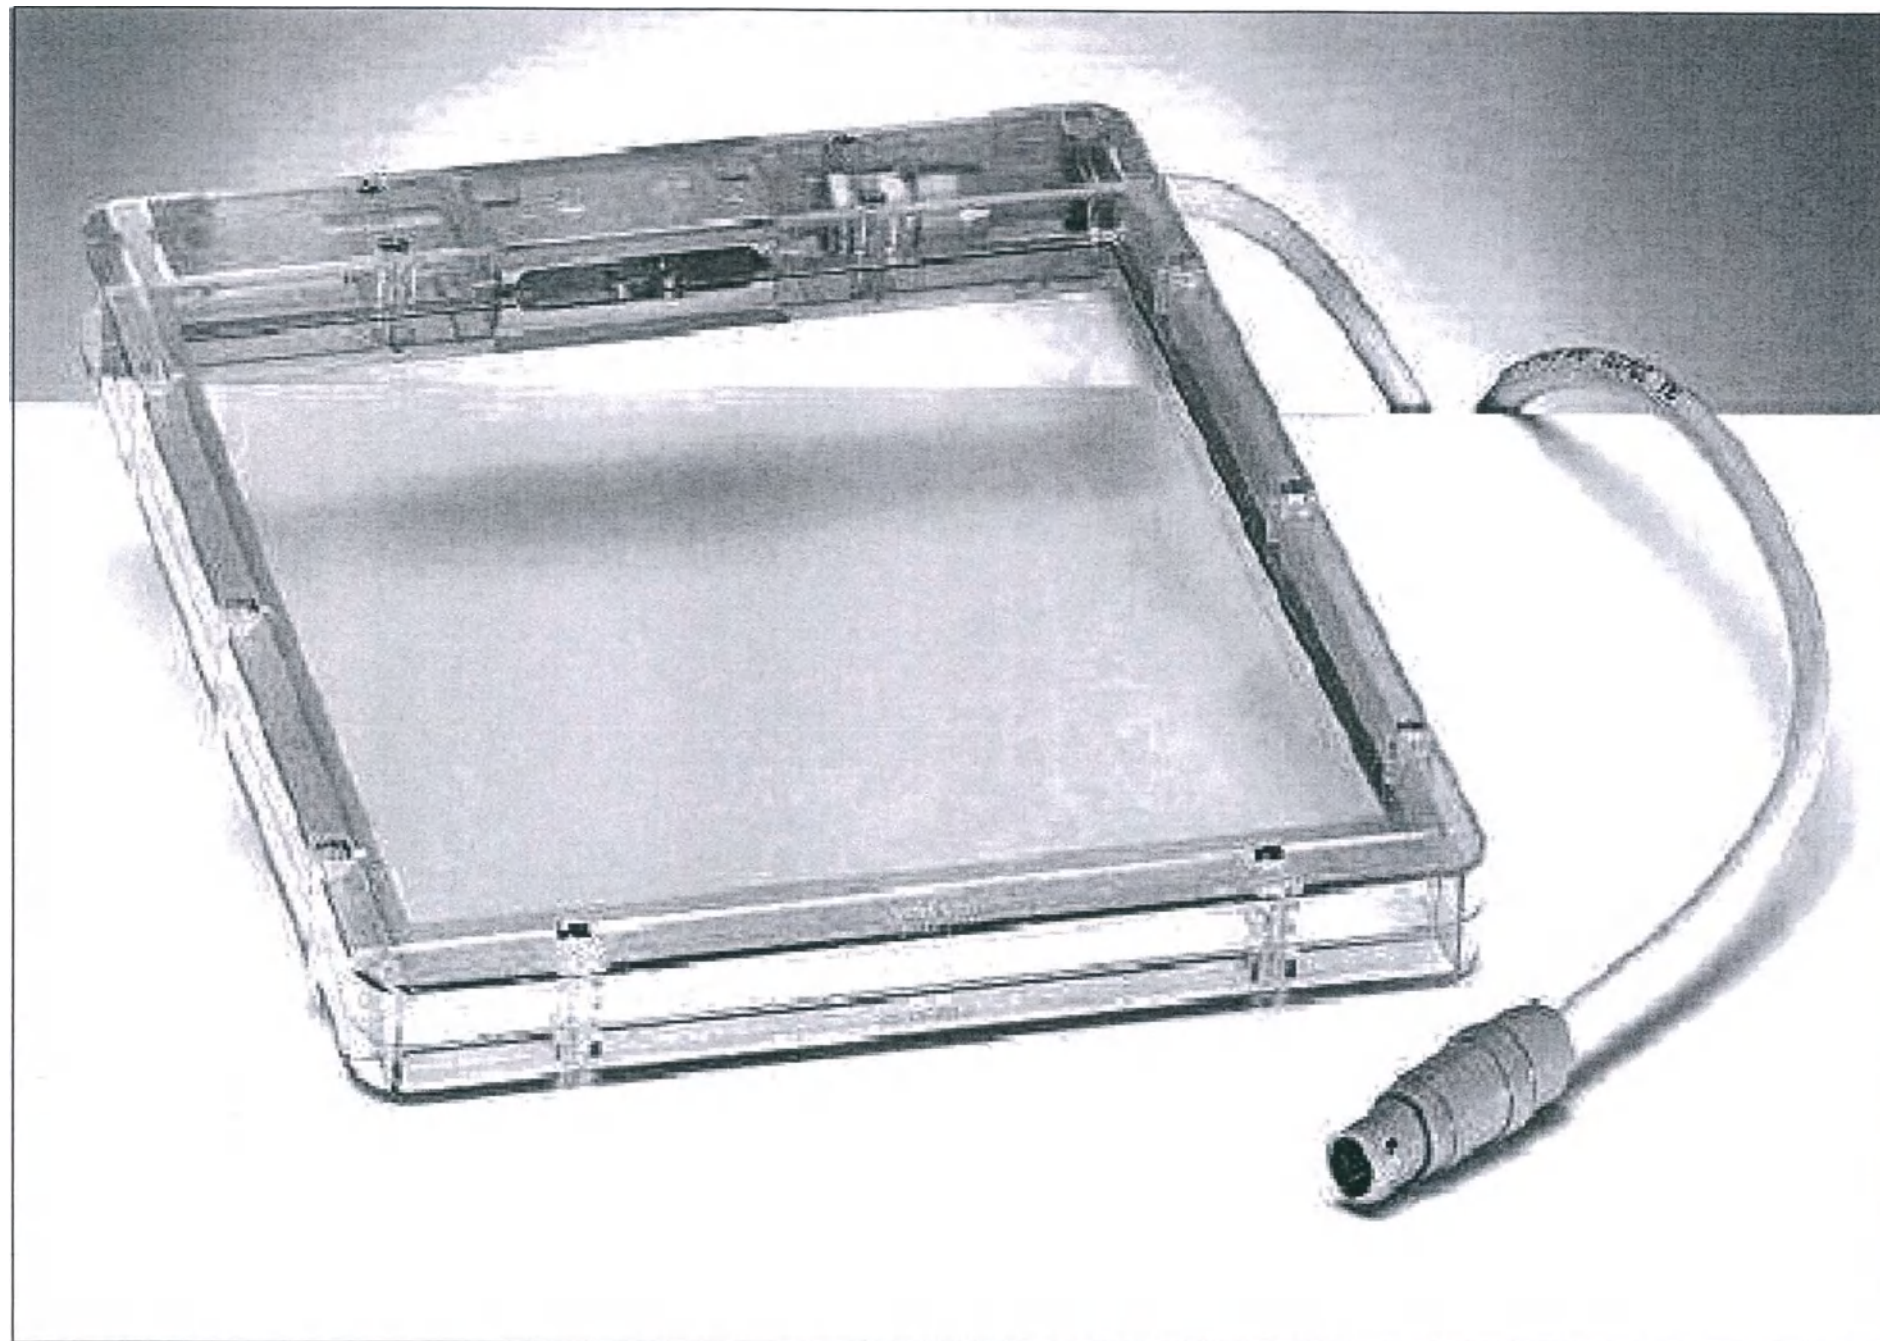


15.6. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

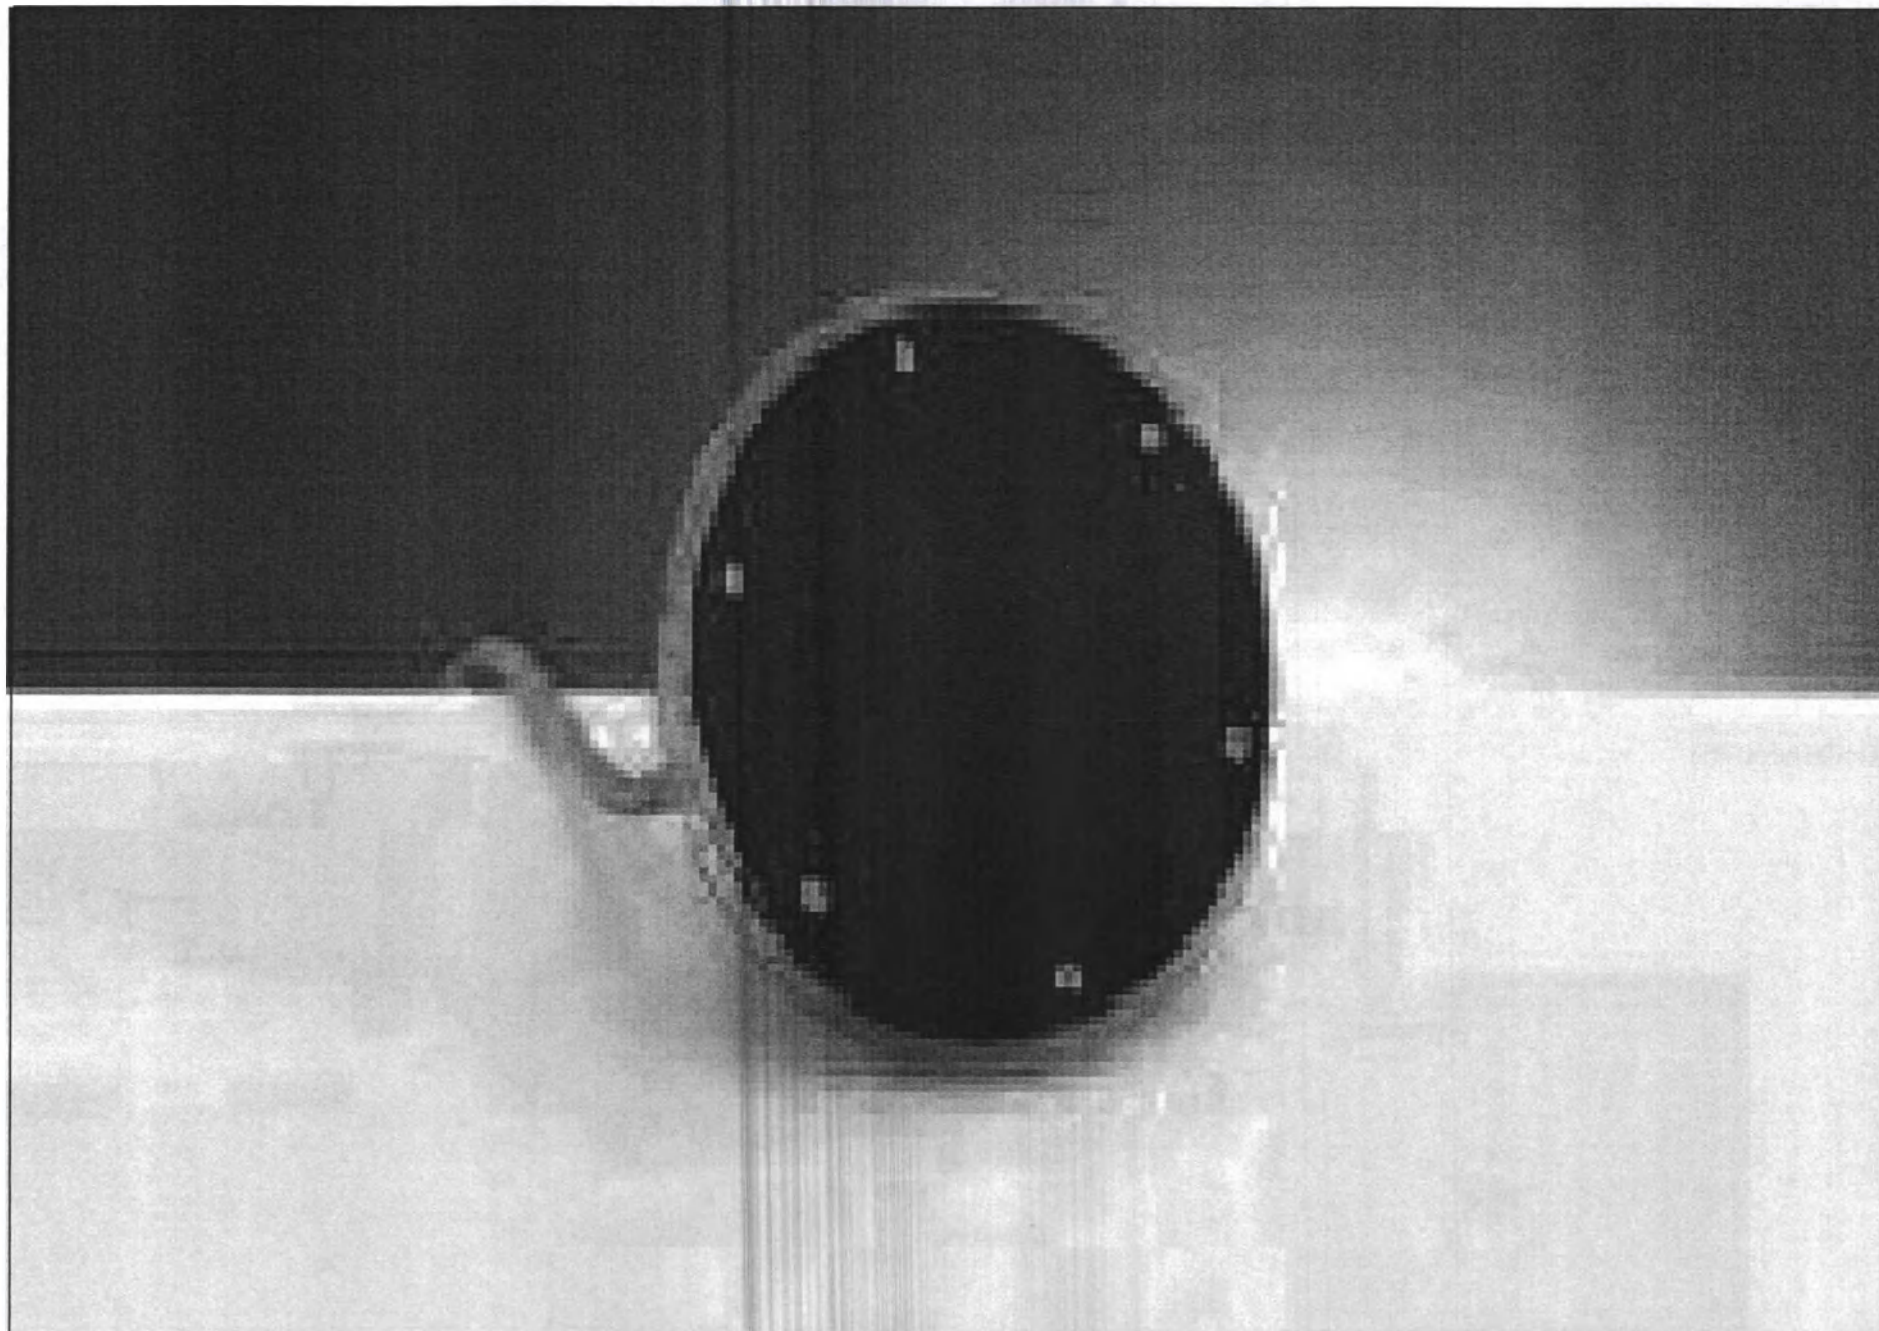


15.в. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

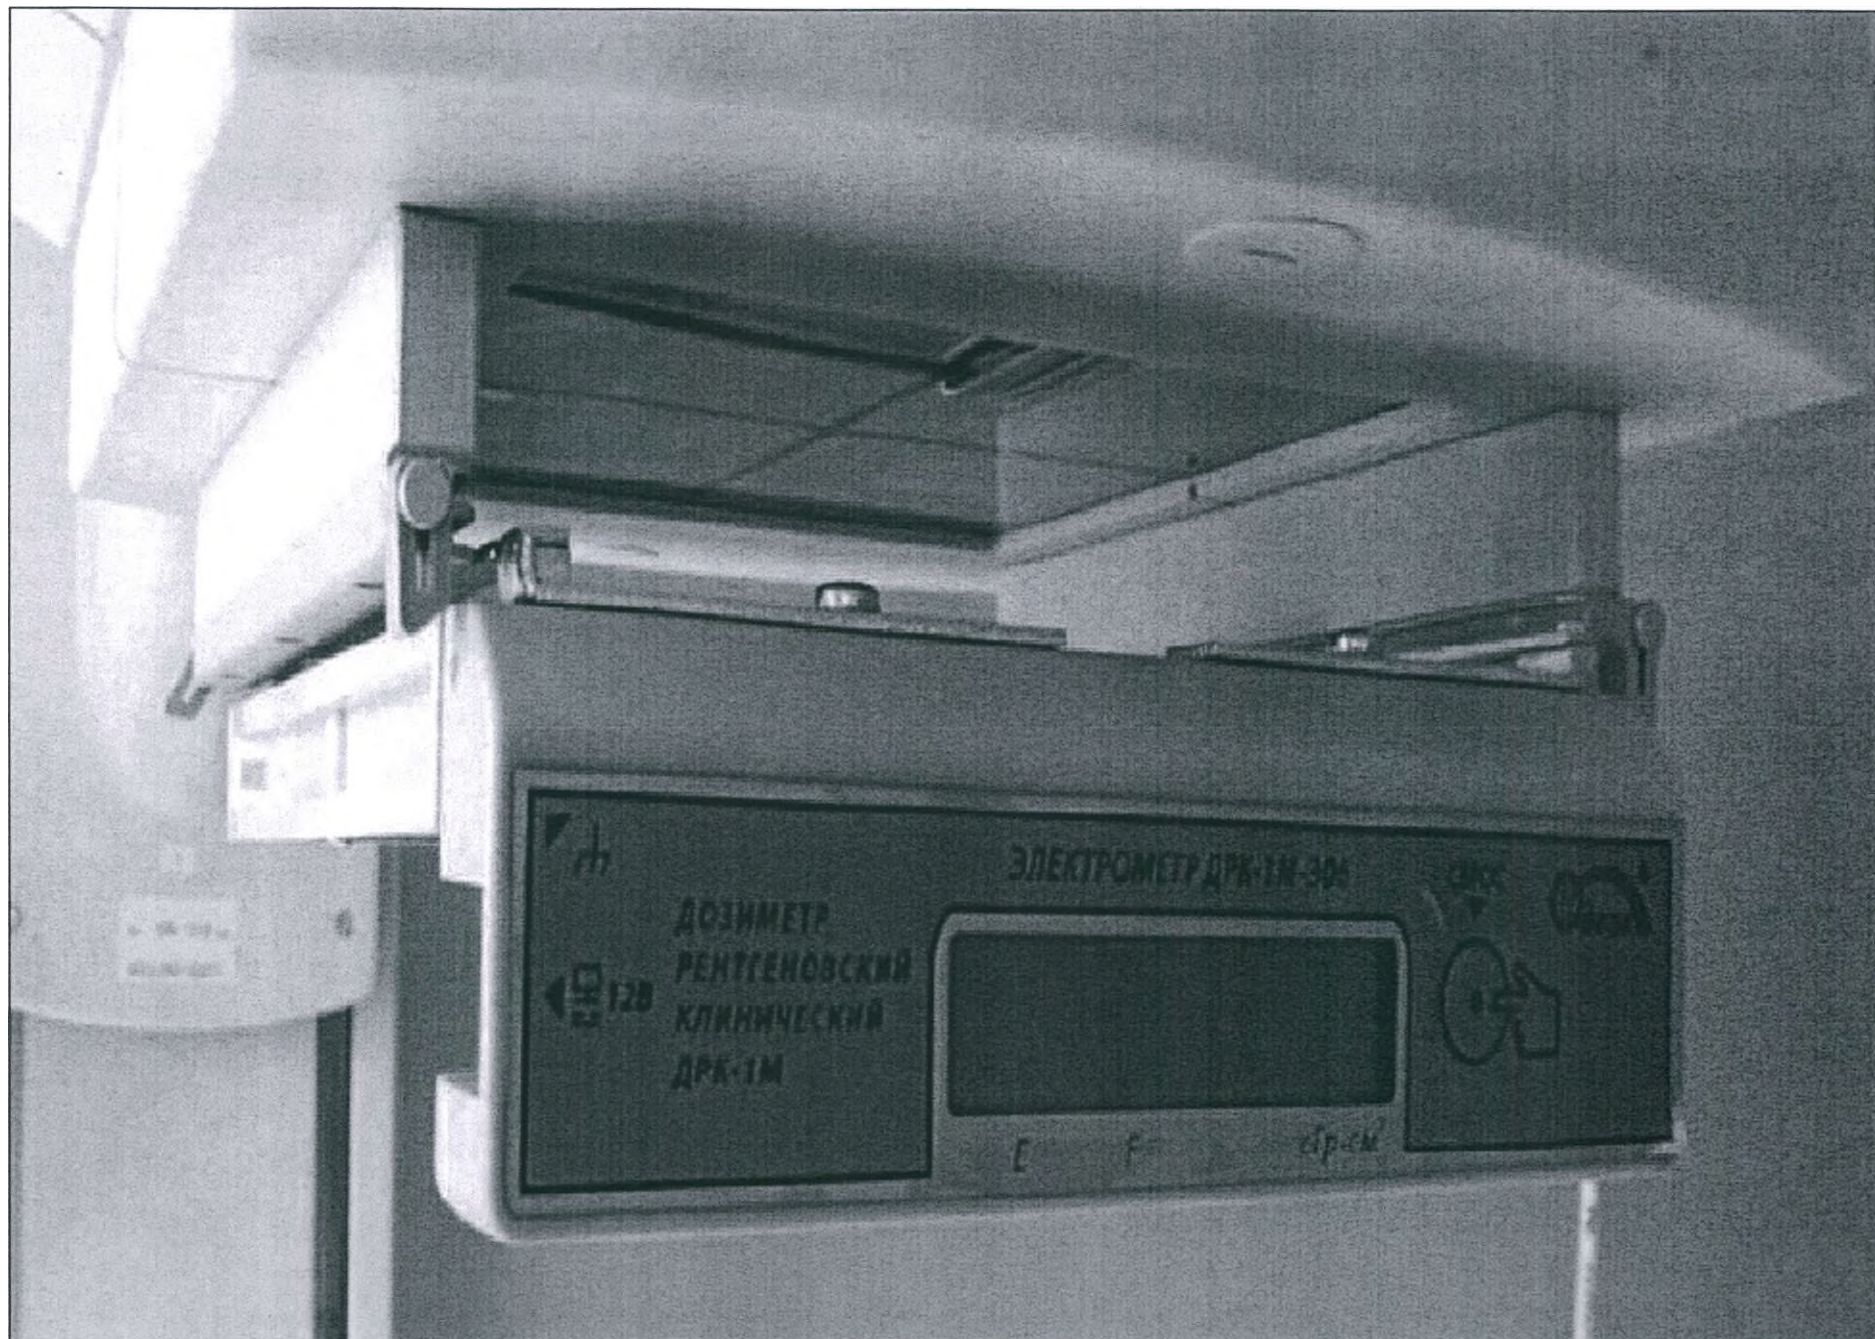


15.2. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

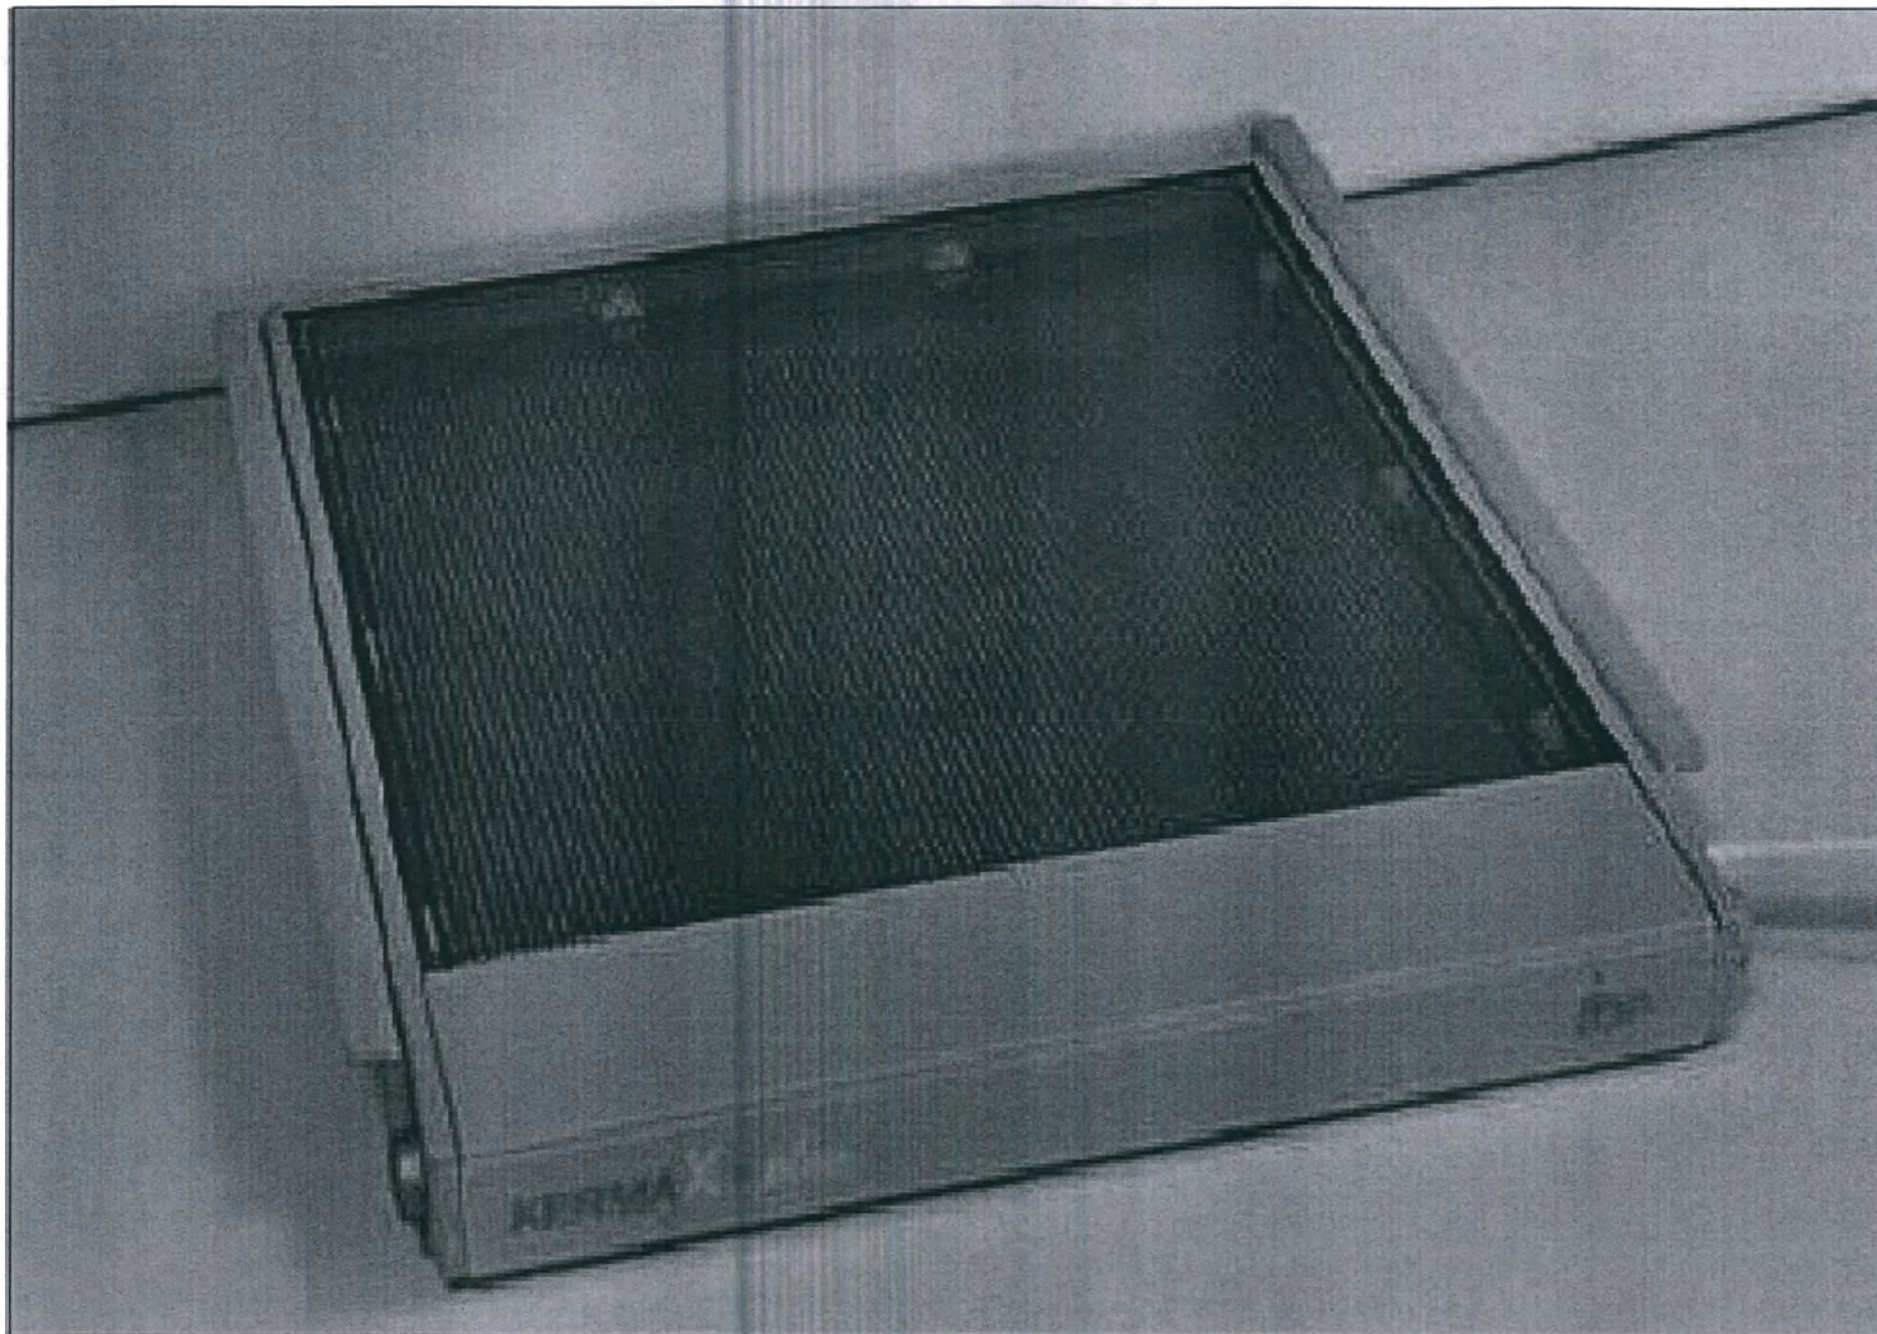

16. Измеритель производства дозы на площадь KermaX plus 120-132.

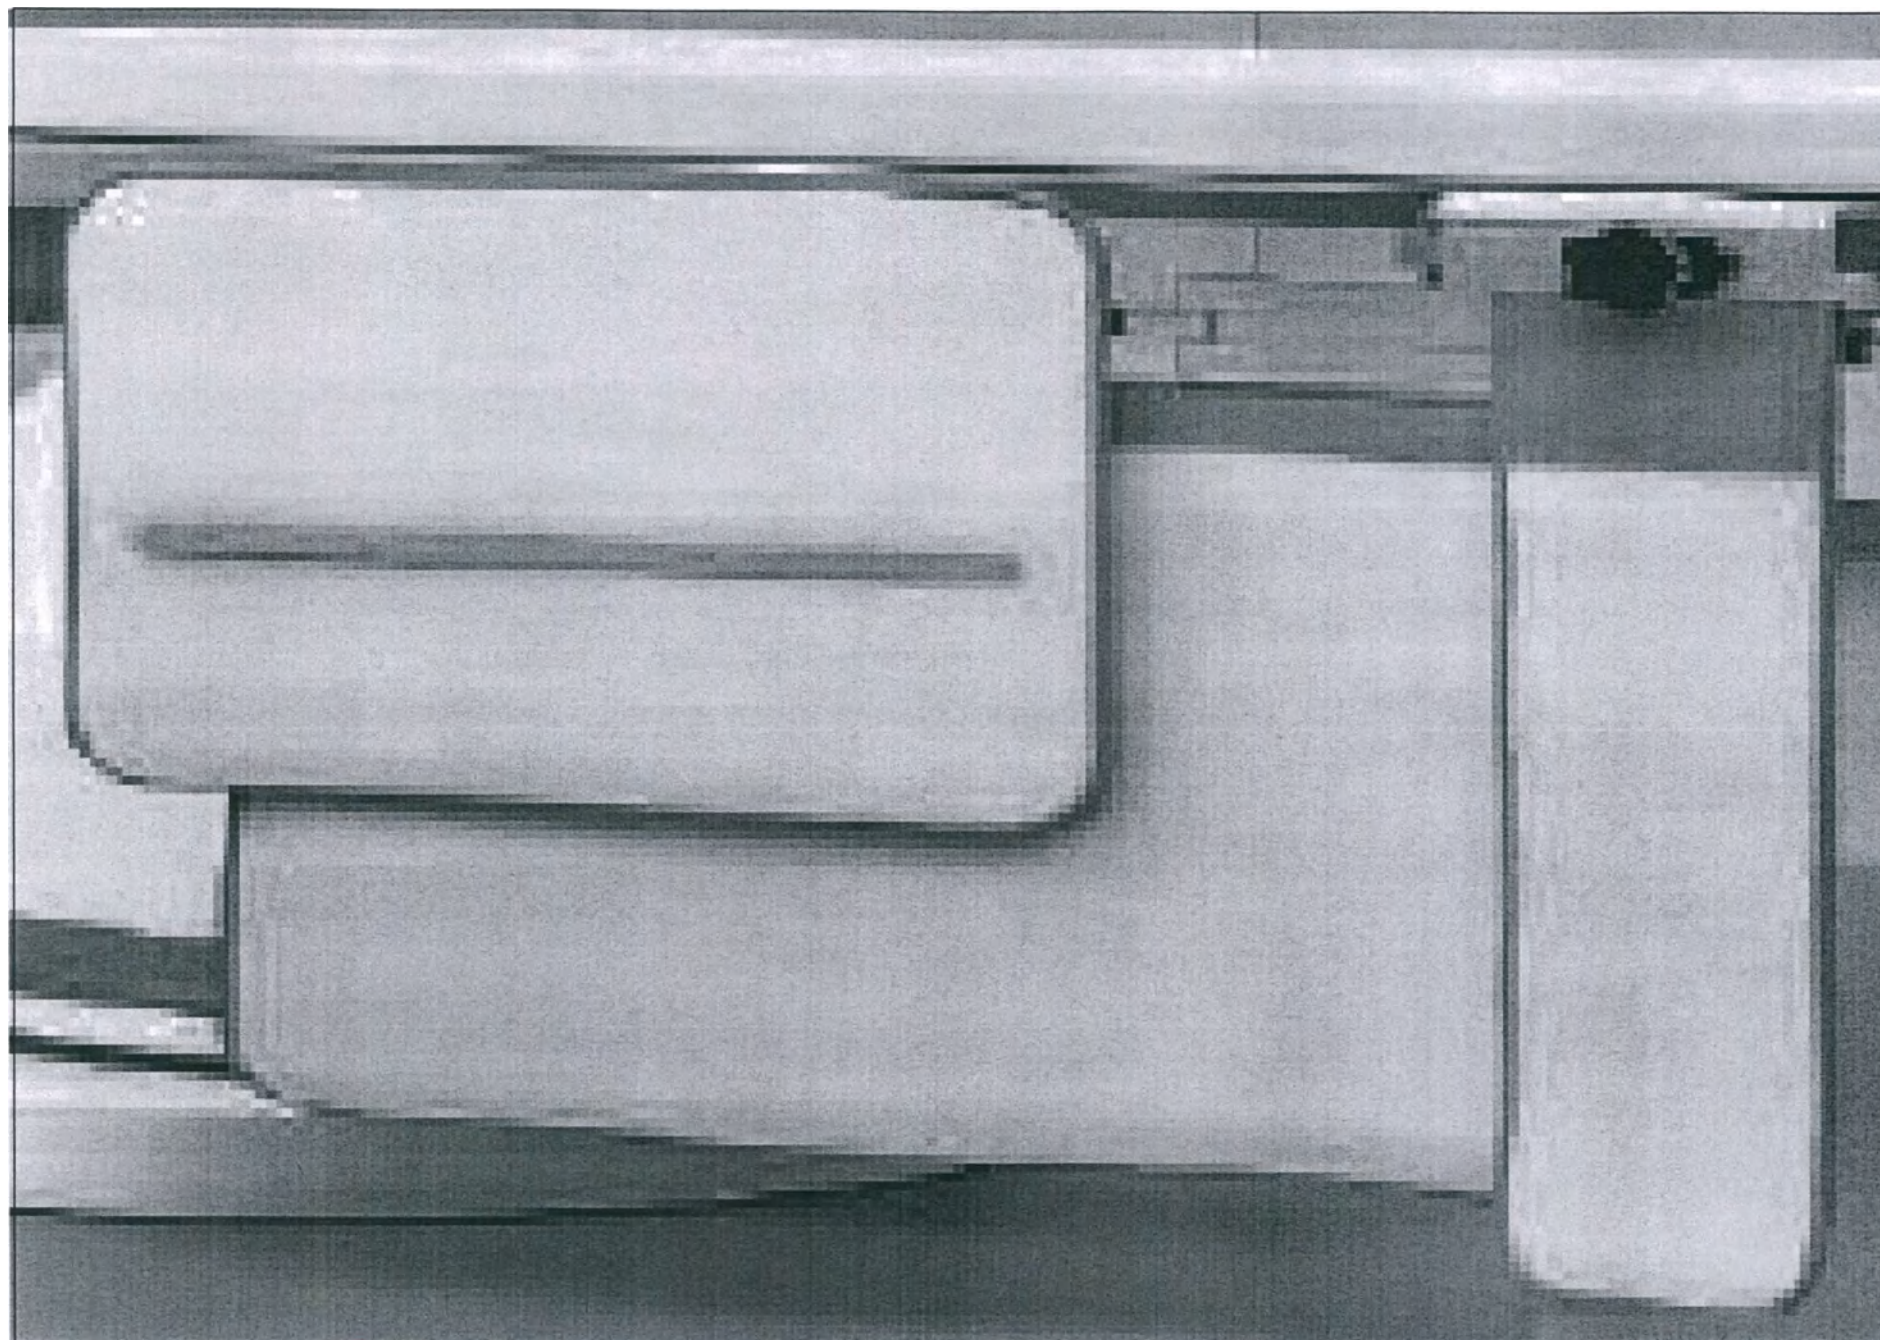


17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

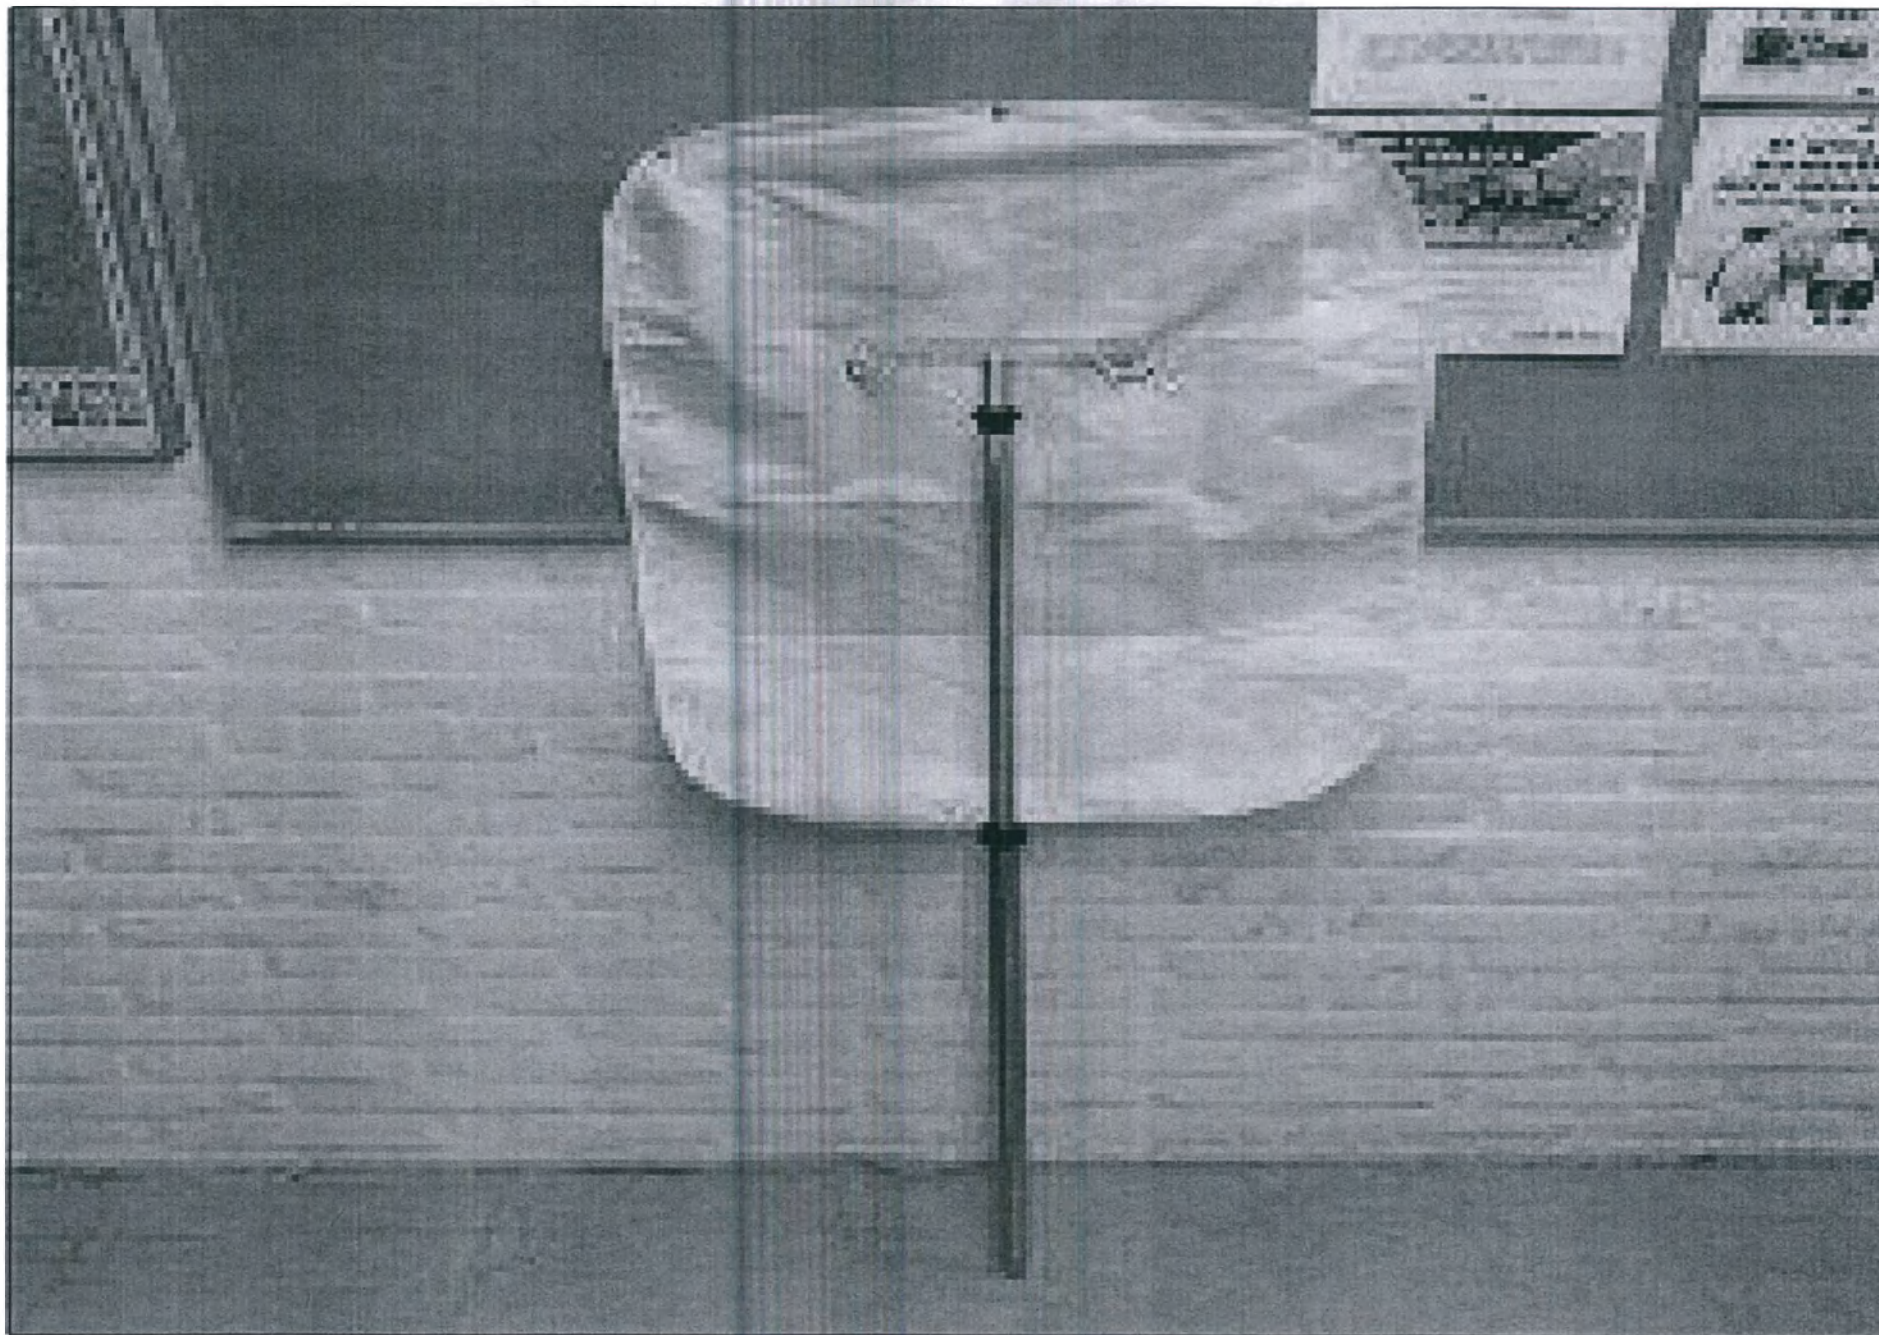


18. Штатив для капельницы, не более 2шт.



19. Лампа для осмотра

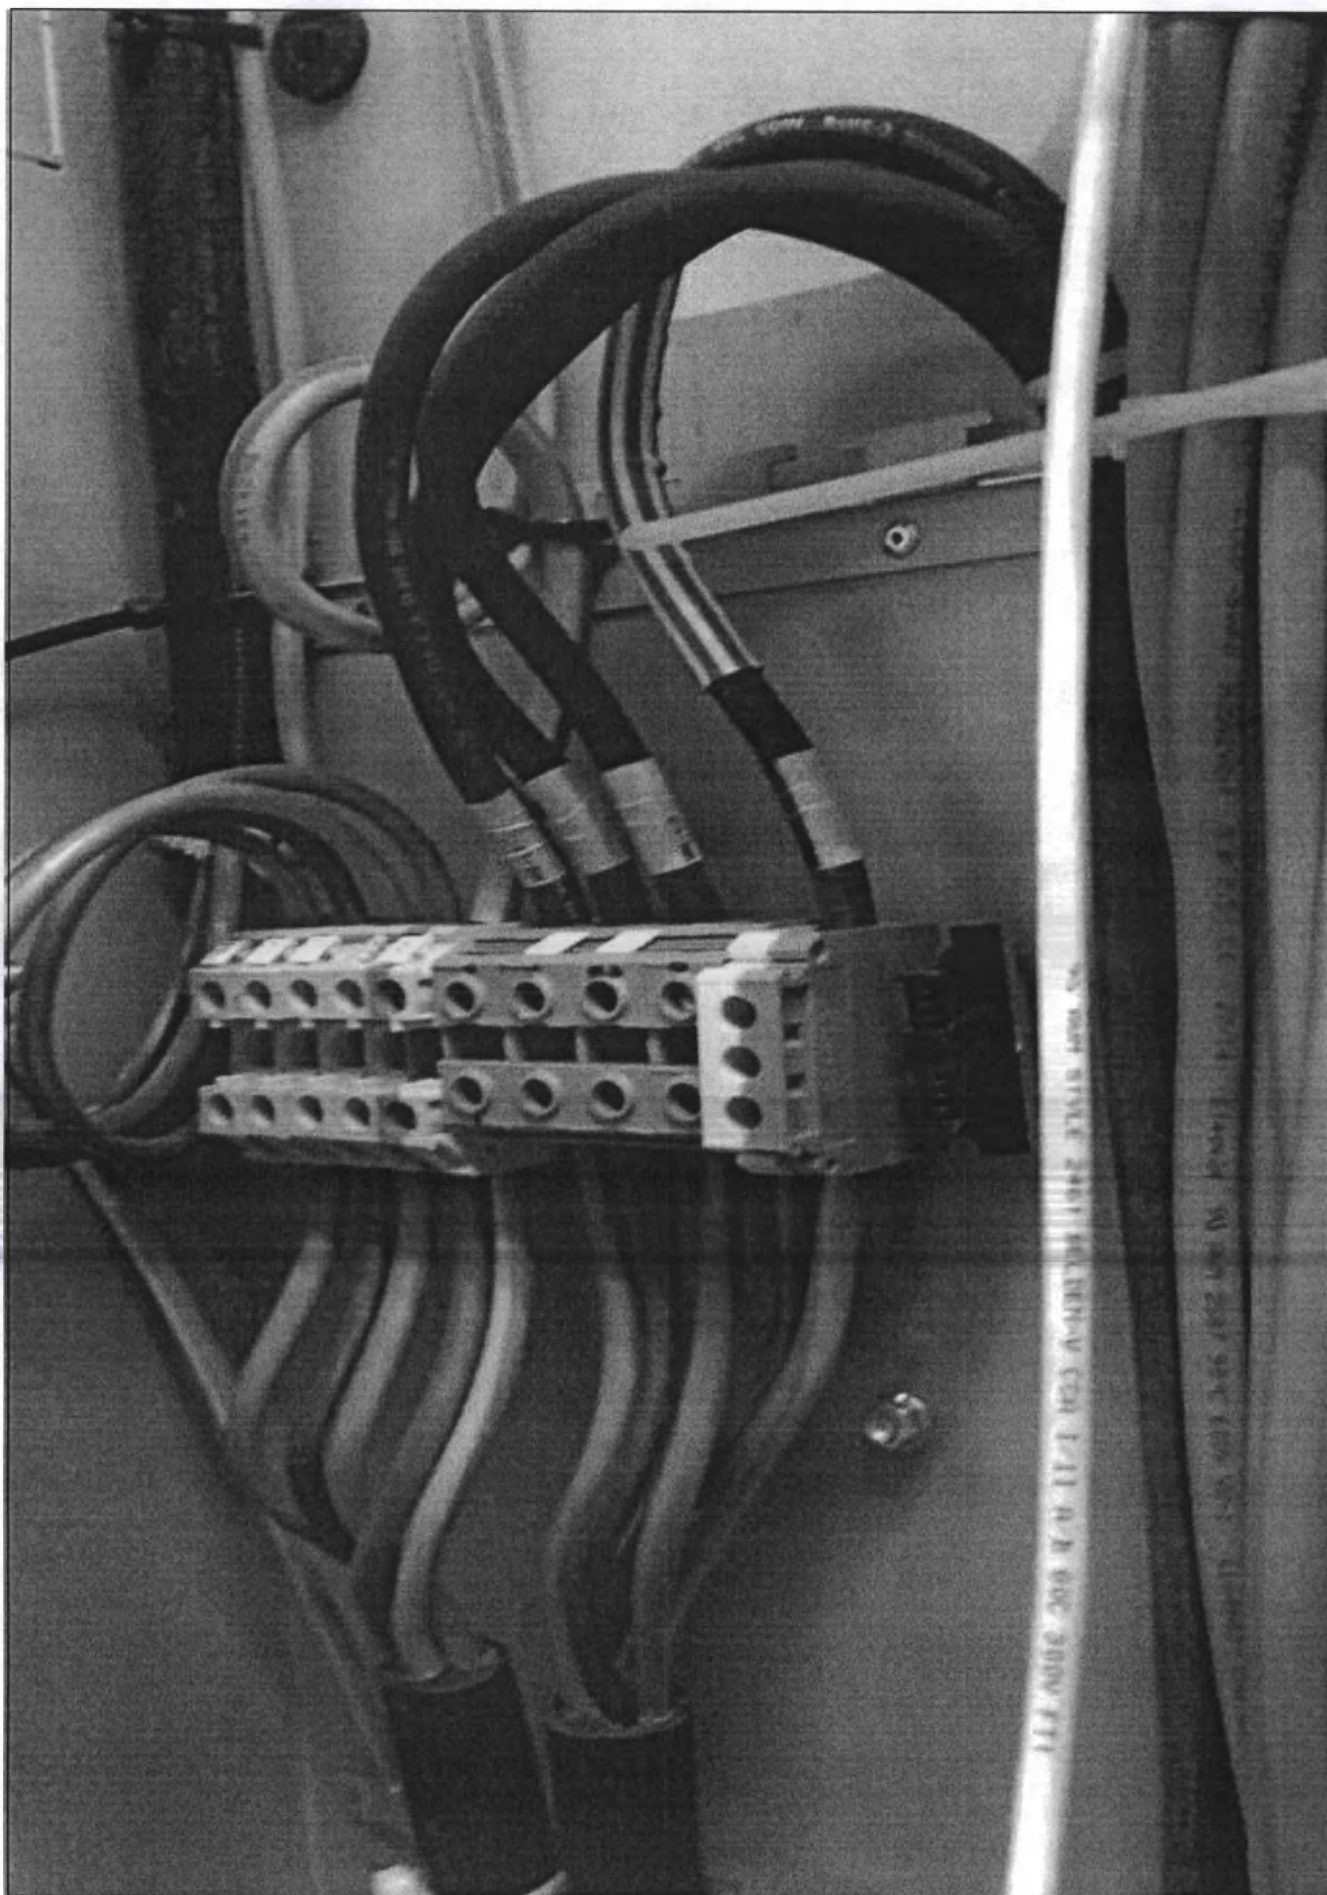

20. Кабели питания.

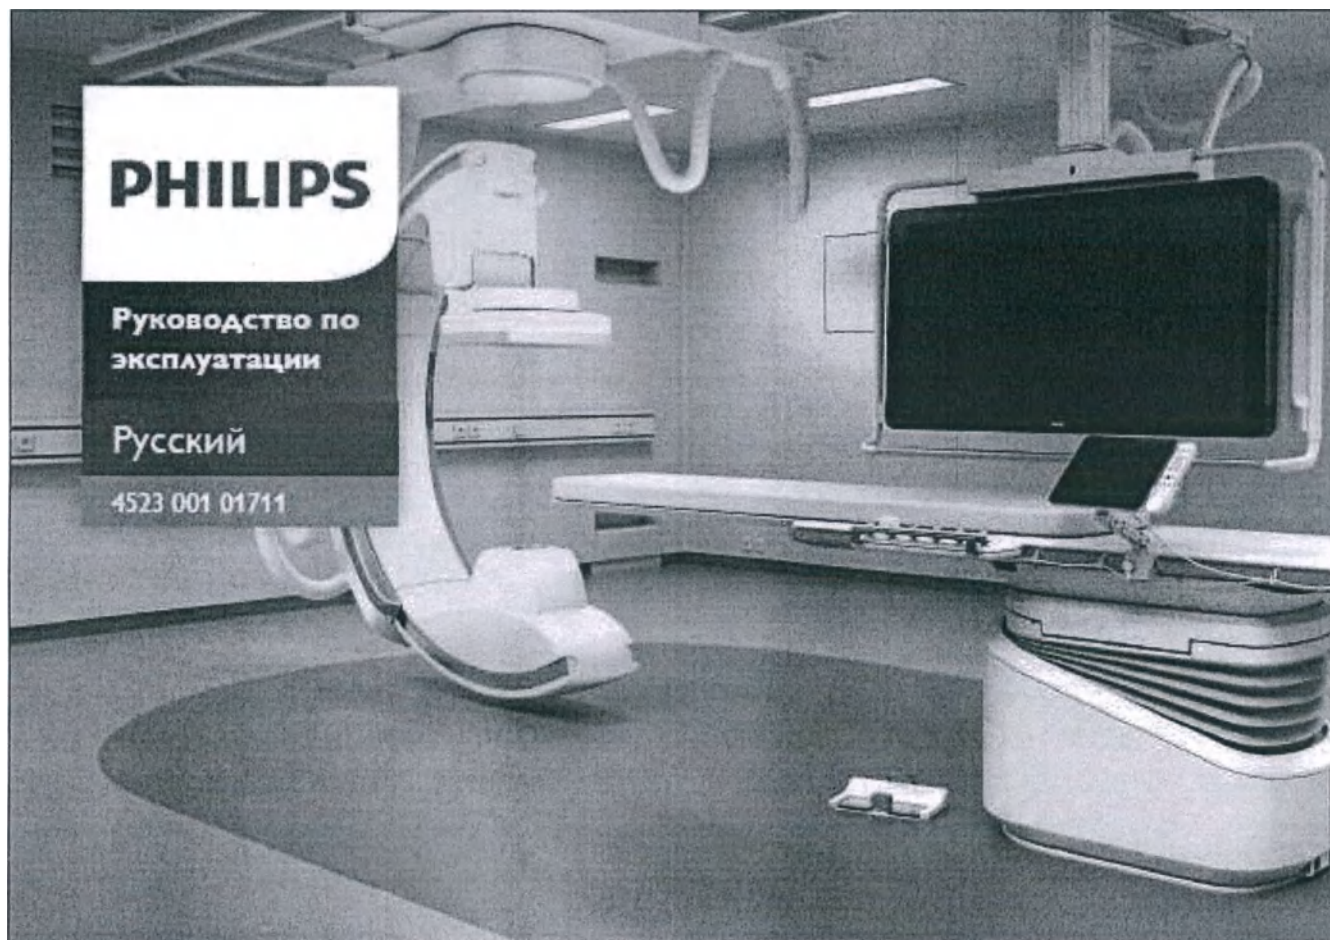

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский


4523 001 01711

Philips Azurion


Версия 2.2

21.6. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 5 M20 (вариант 1), в составе:

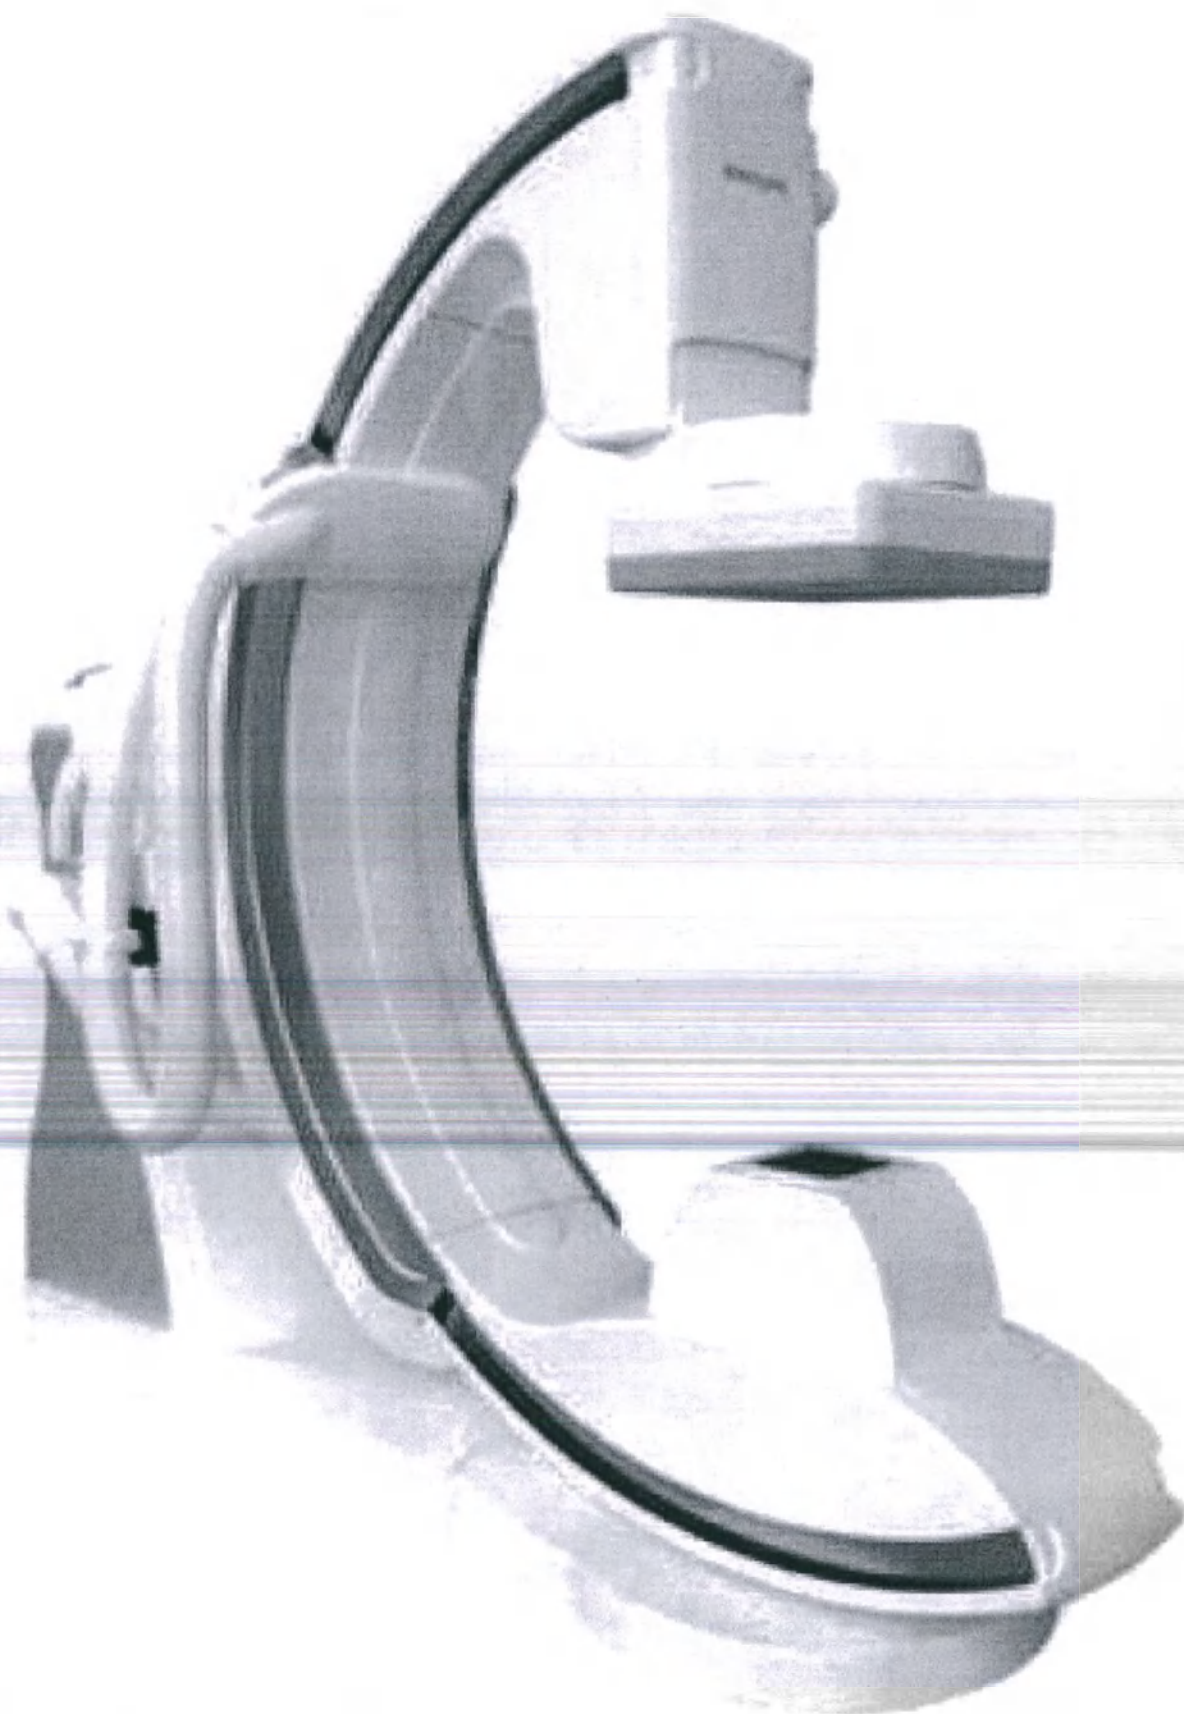


1. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

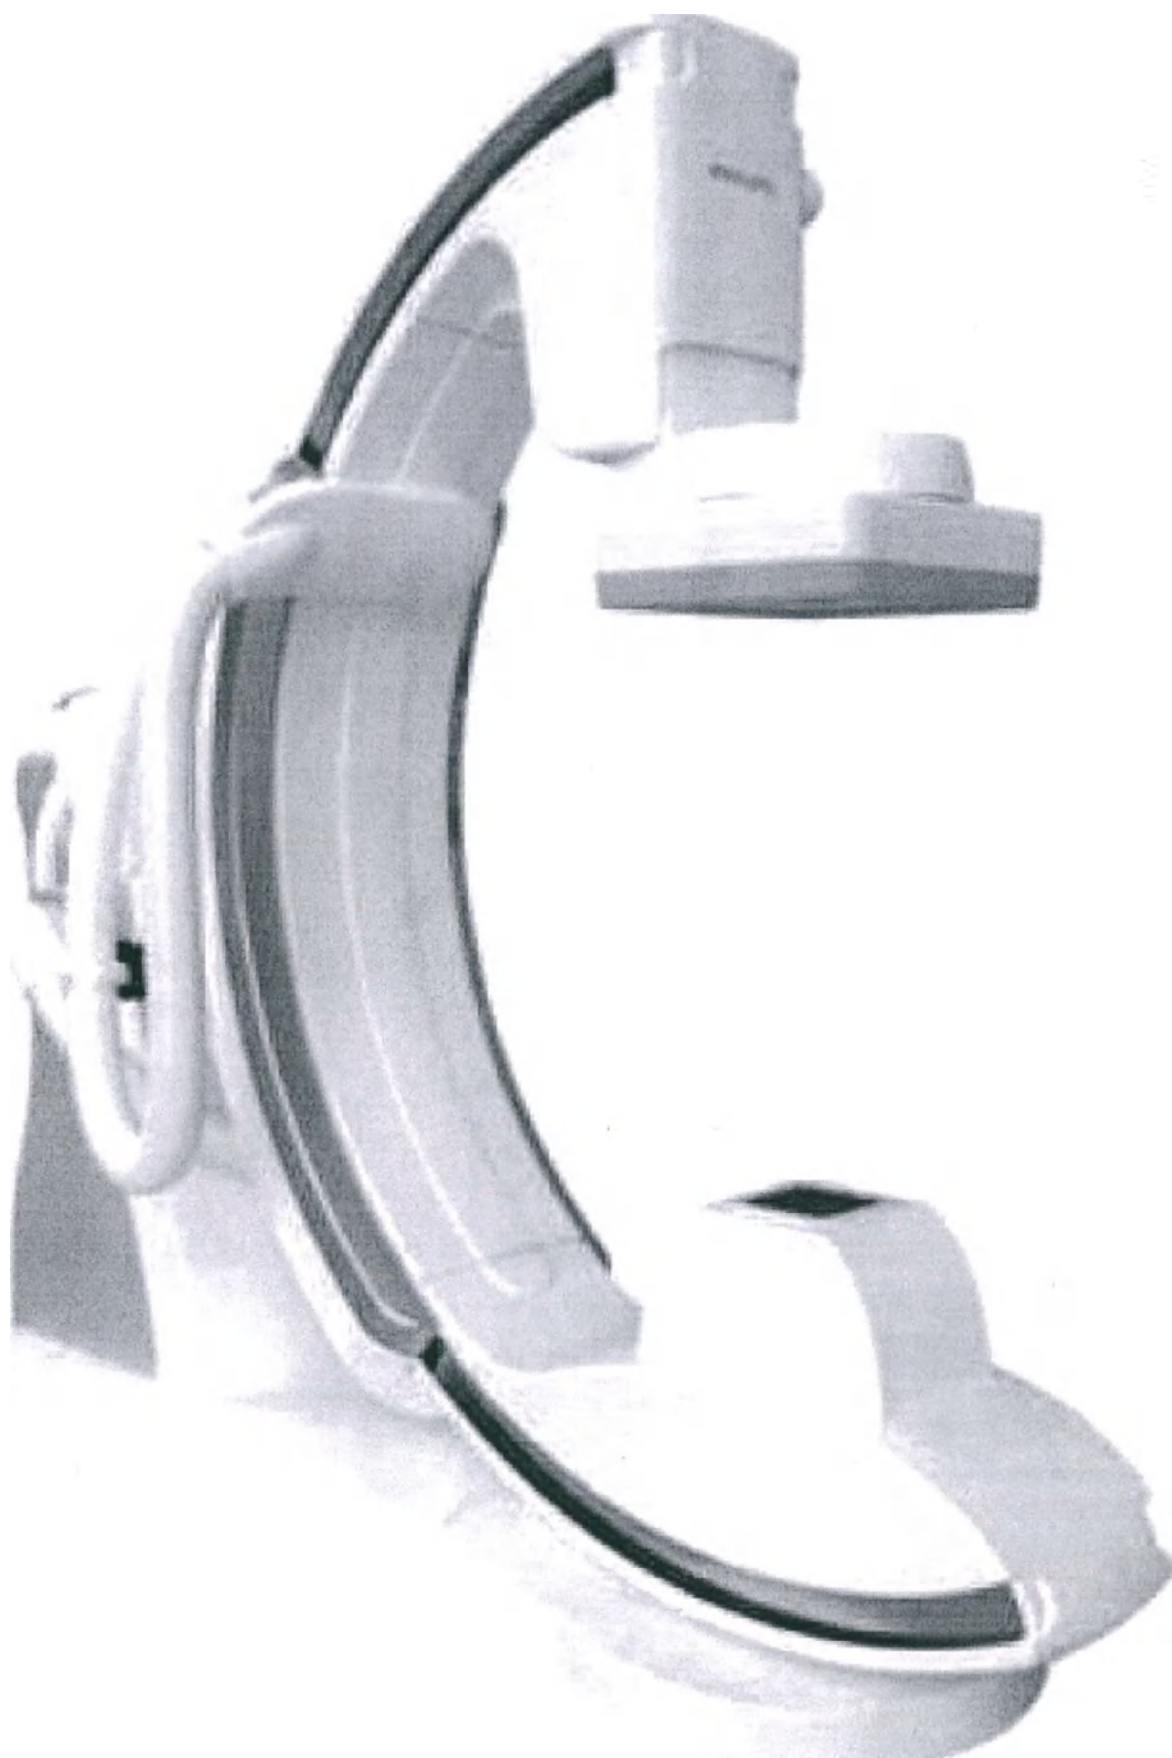


1.а. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

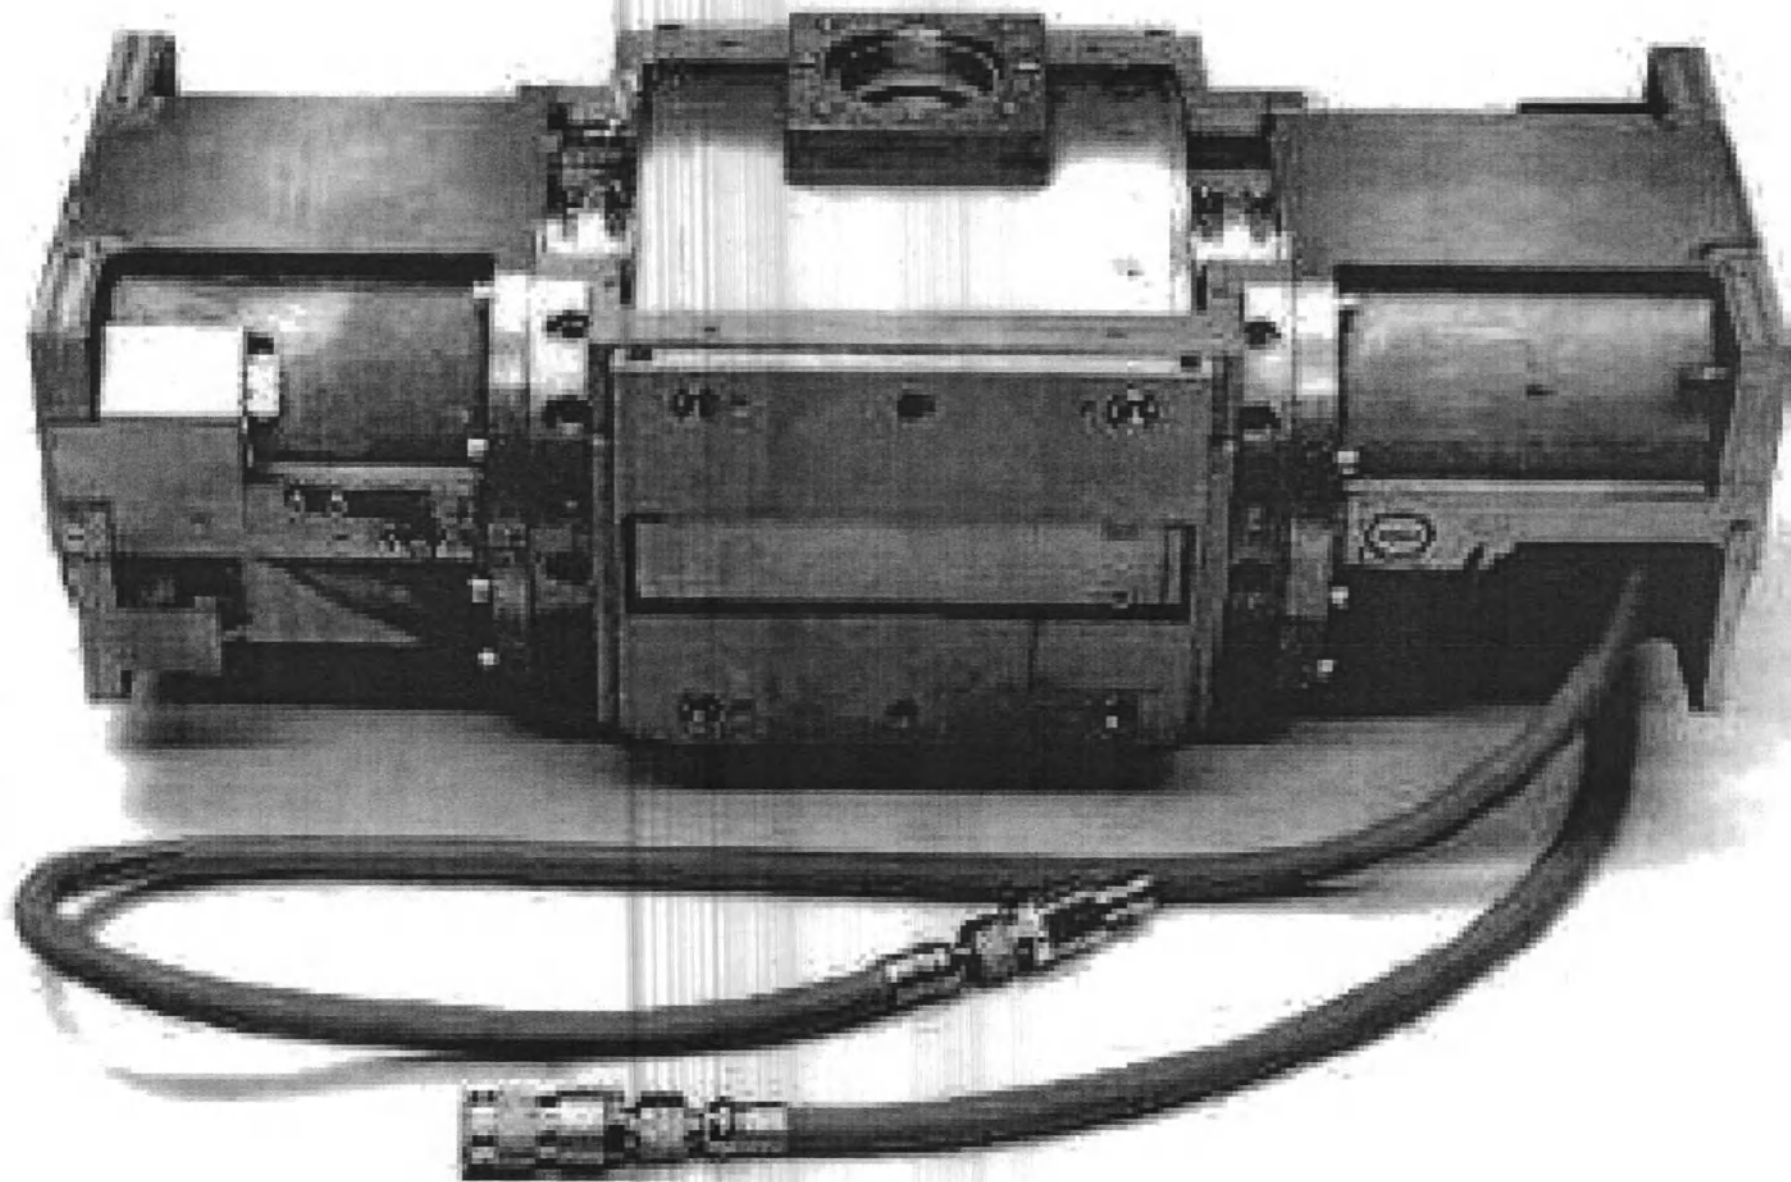


1.6. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

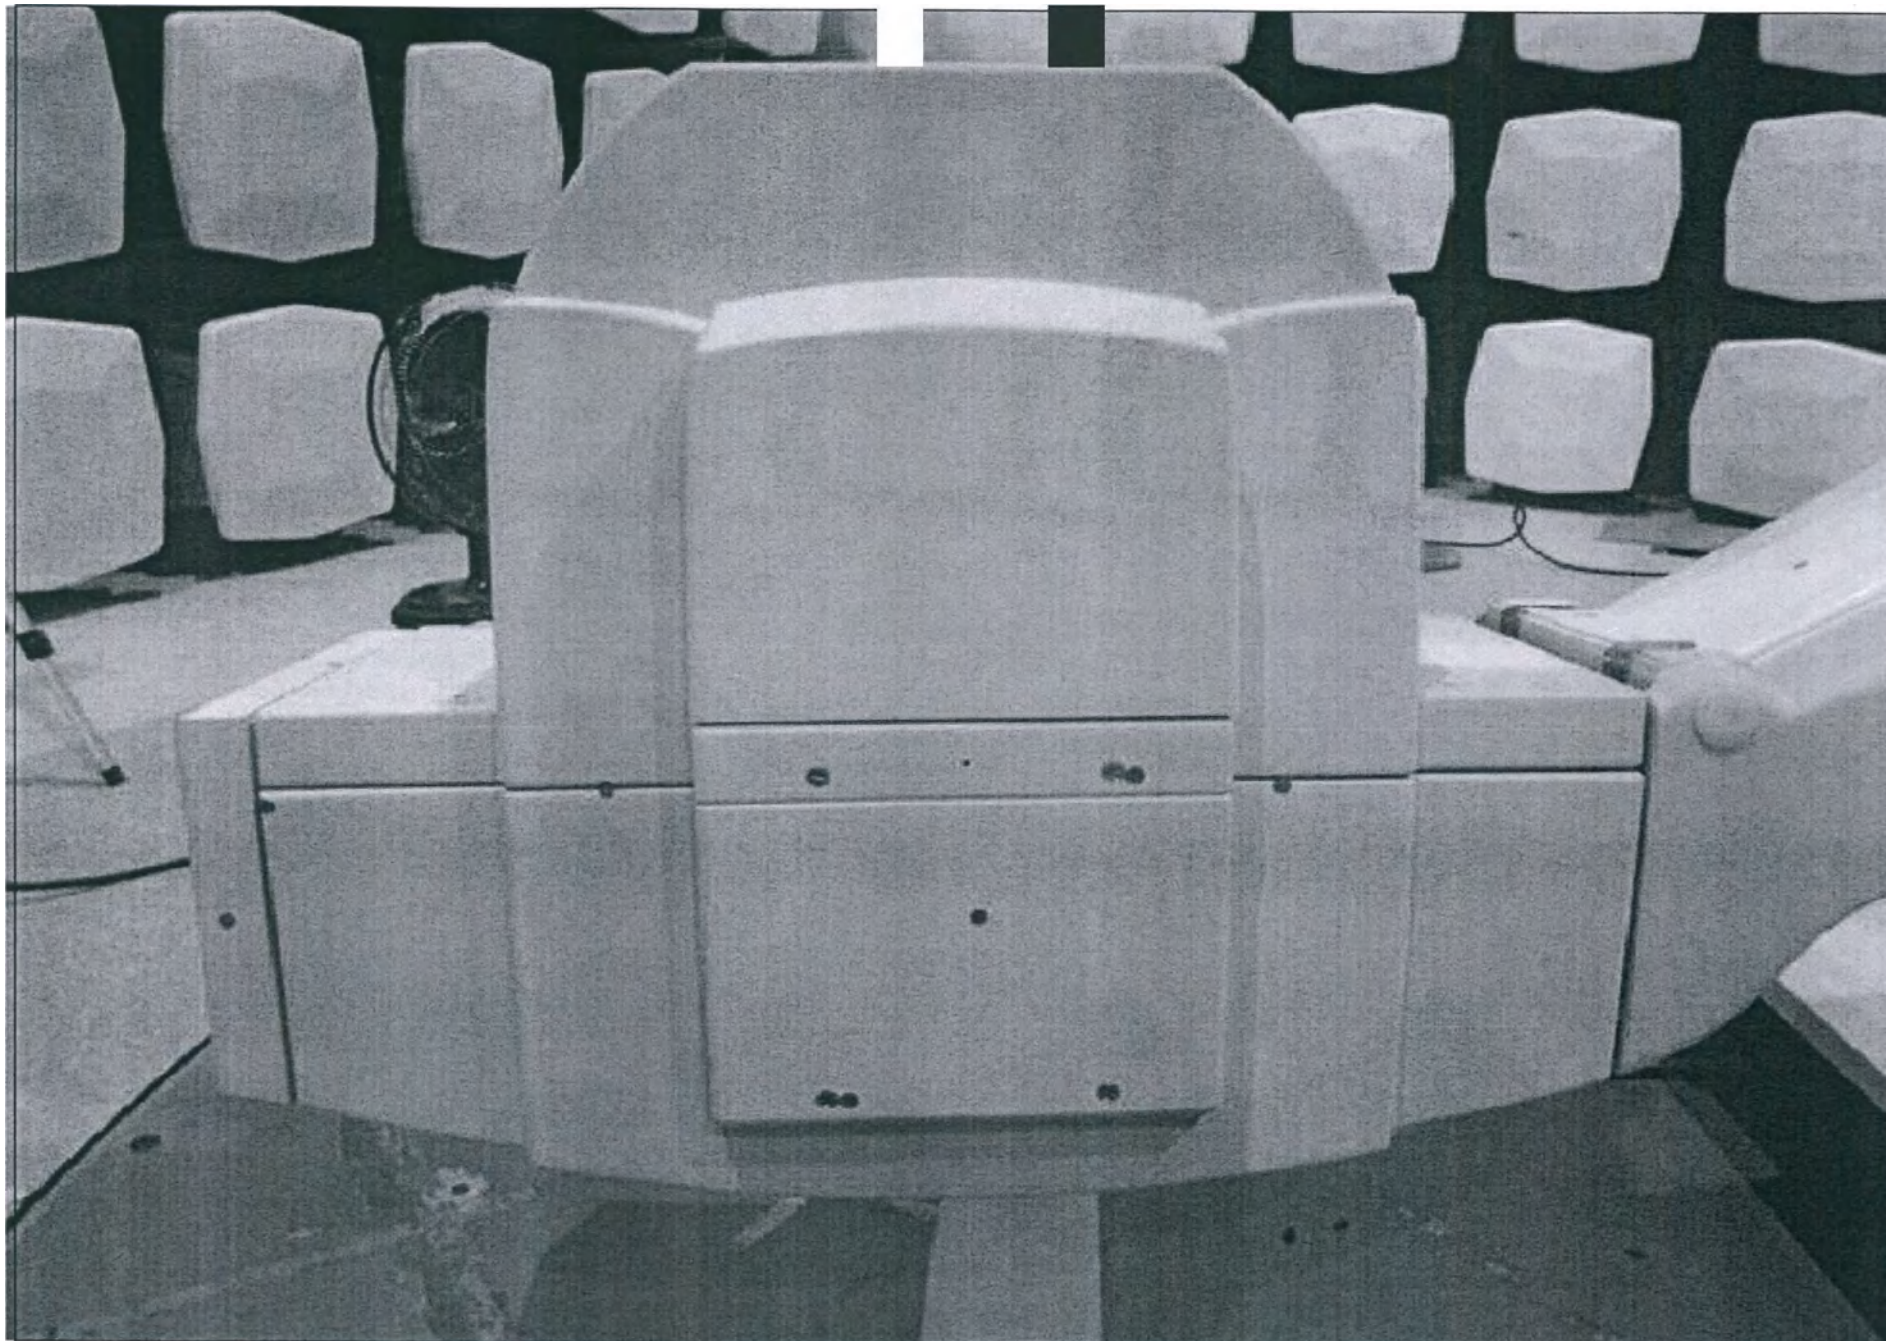


1.в. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

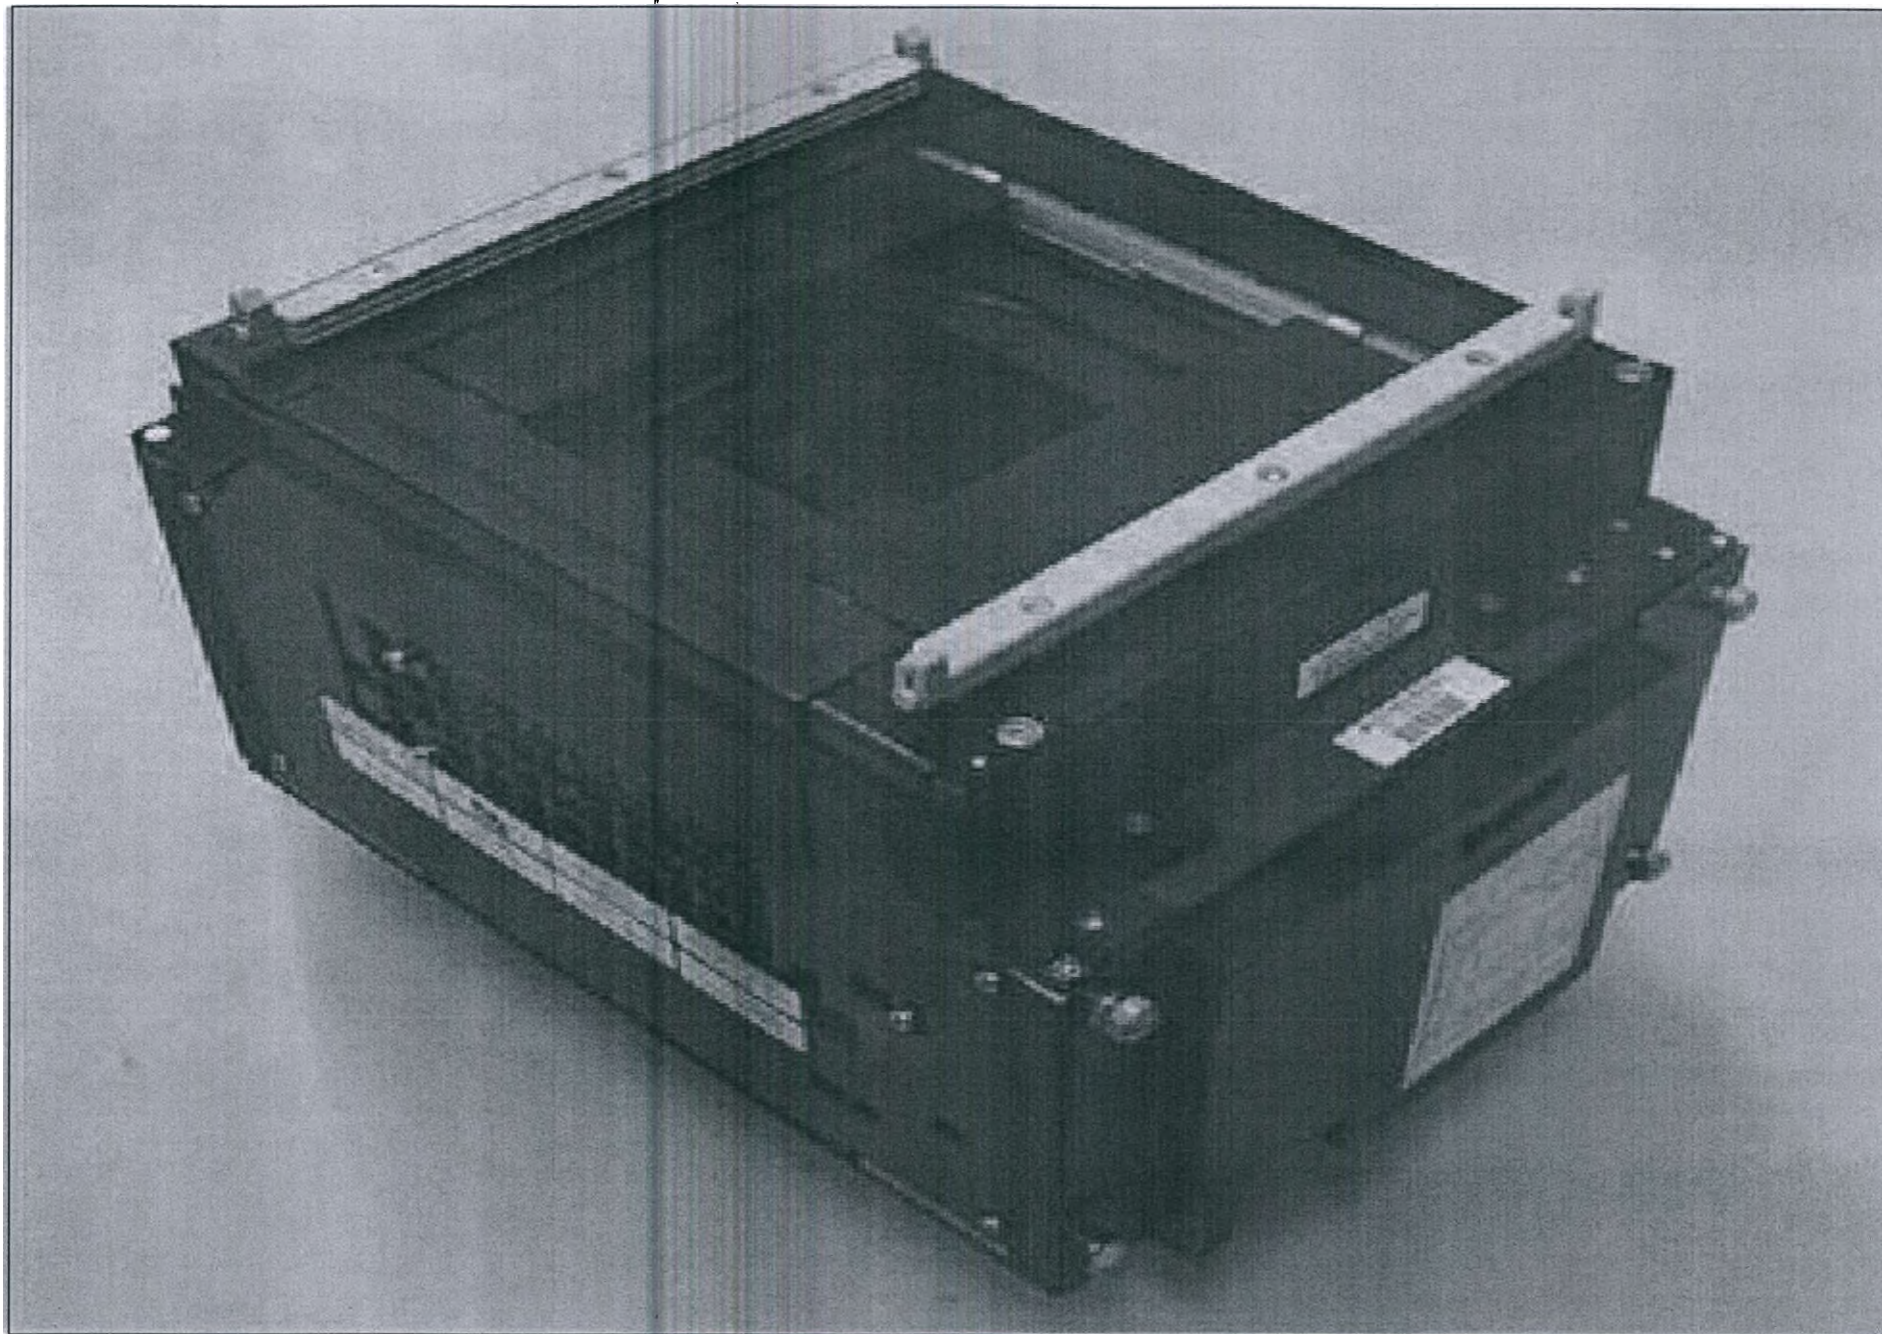


1.2. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

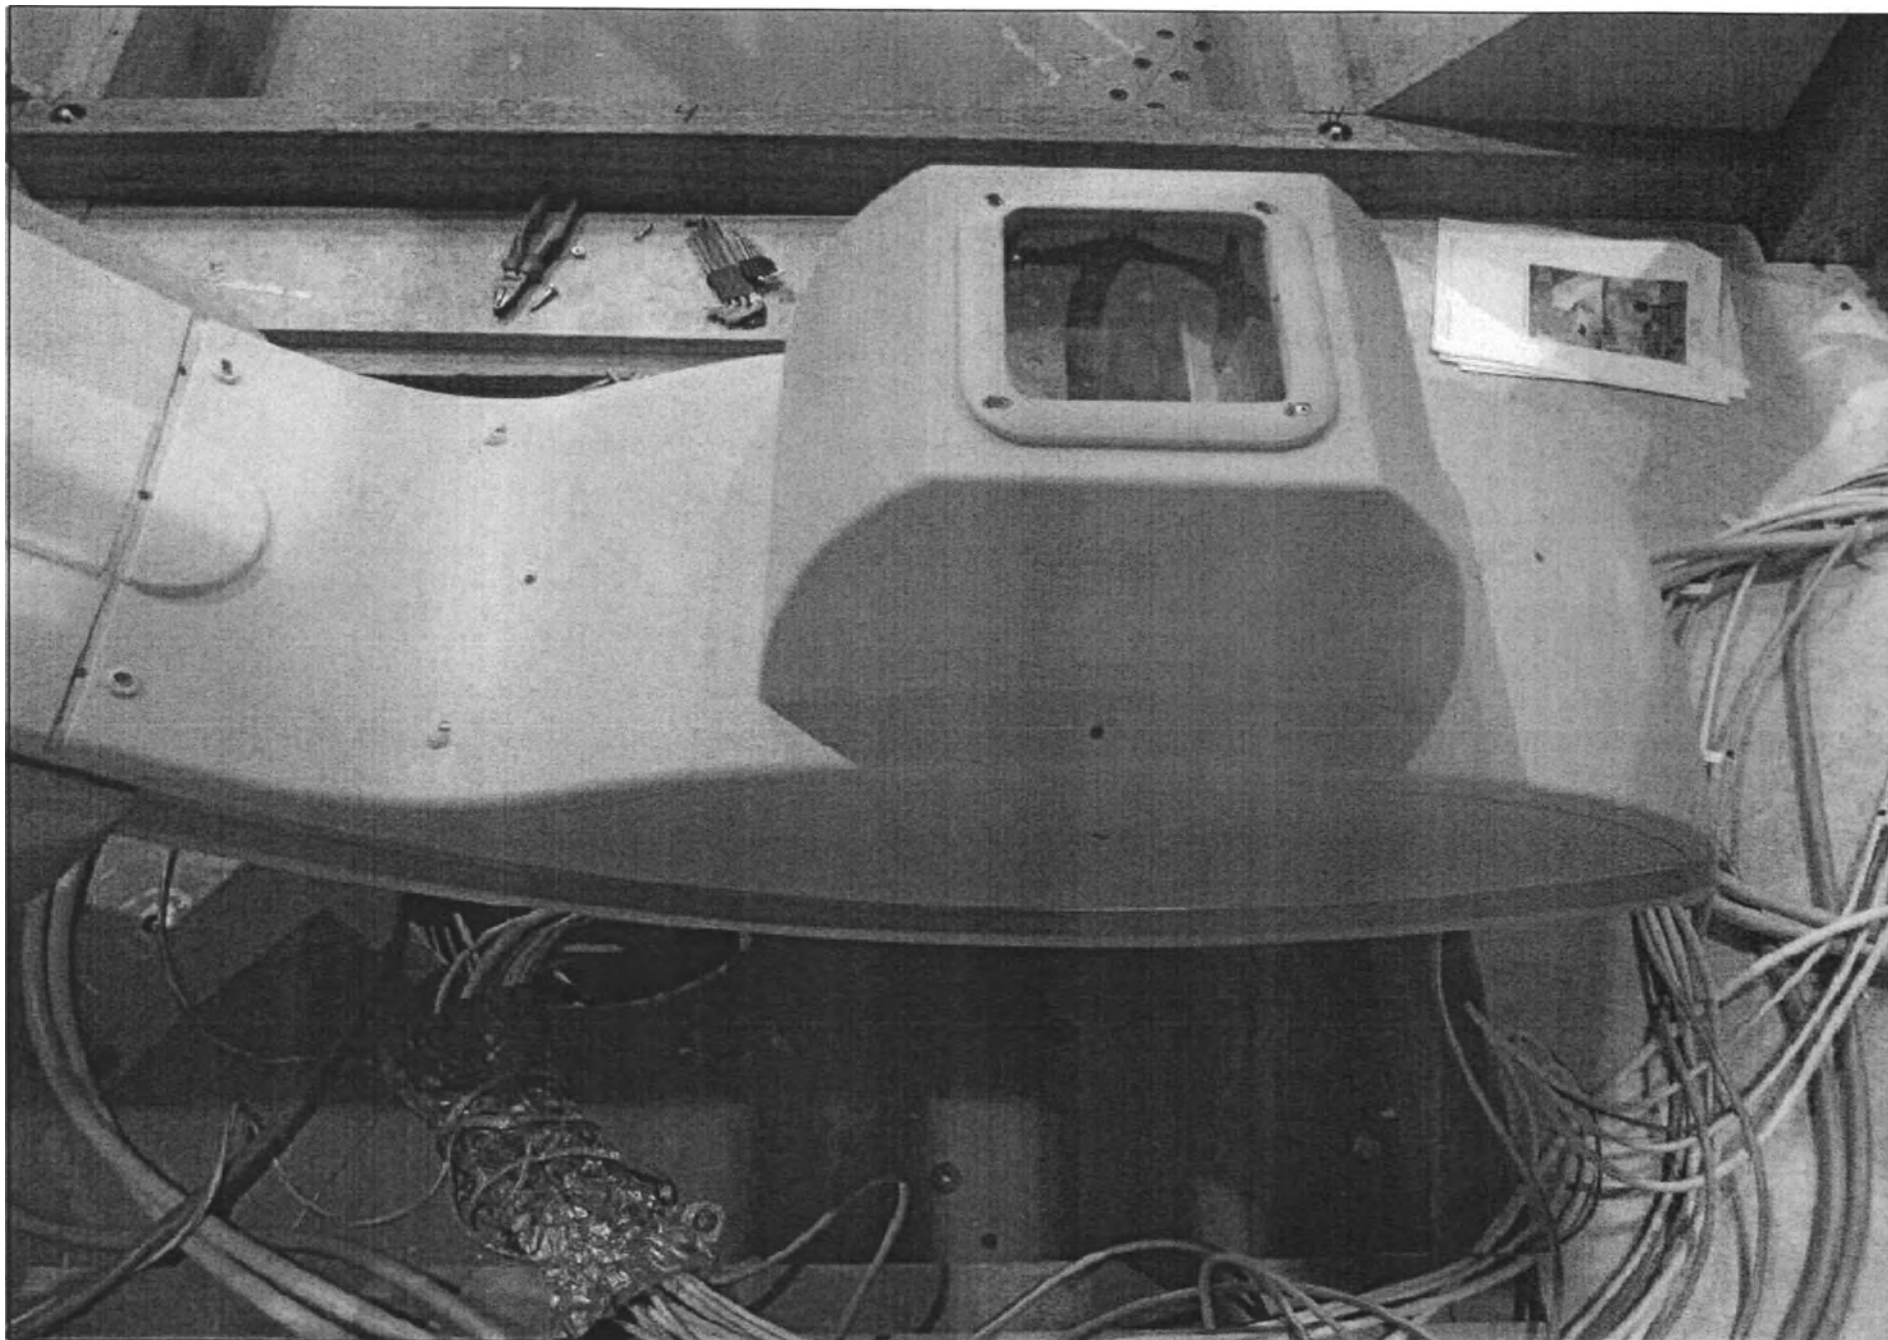


1.д. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

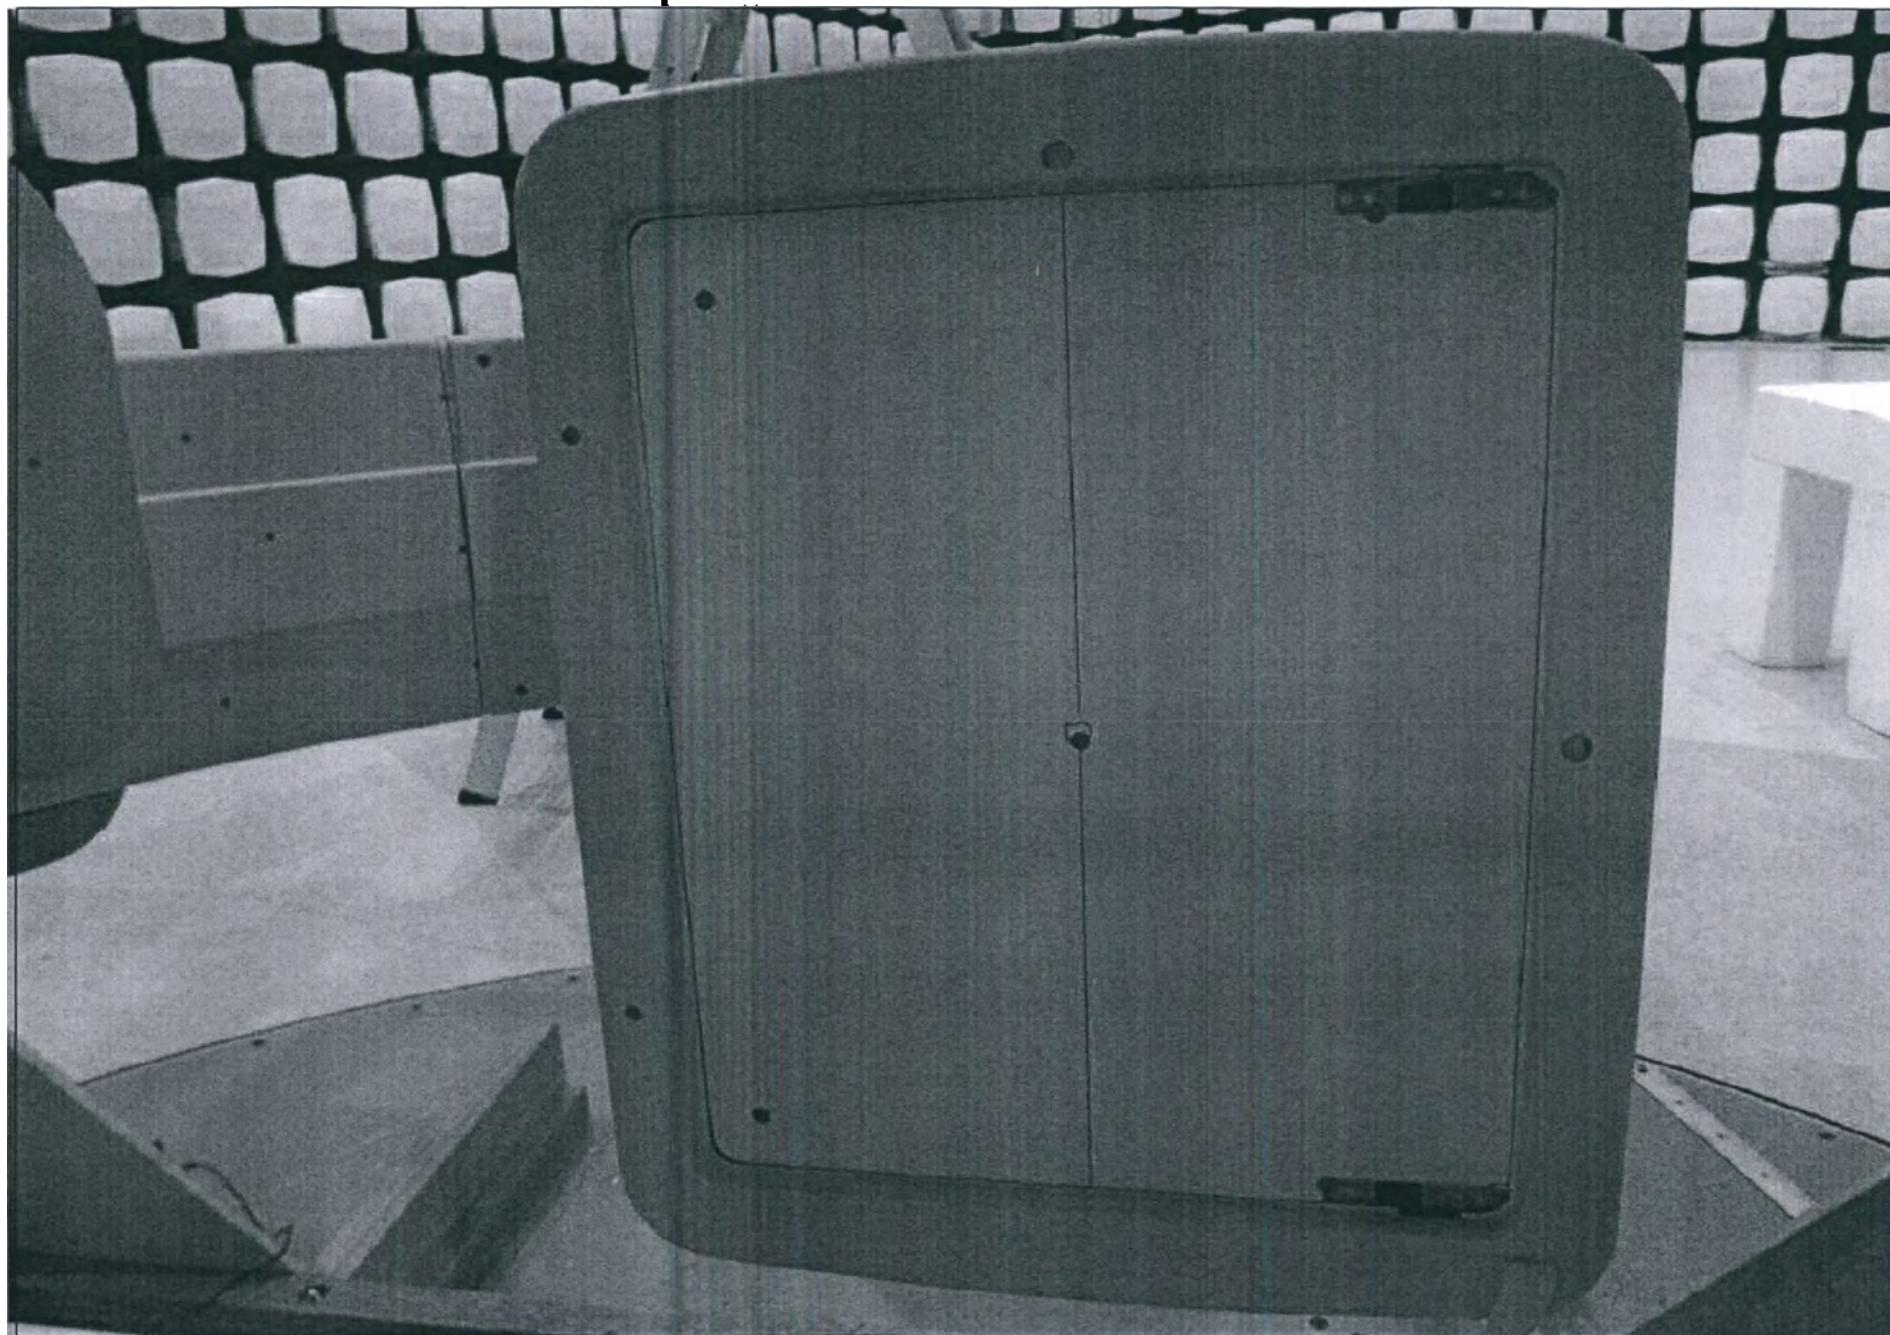


1.е. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с напольным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор F20.

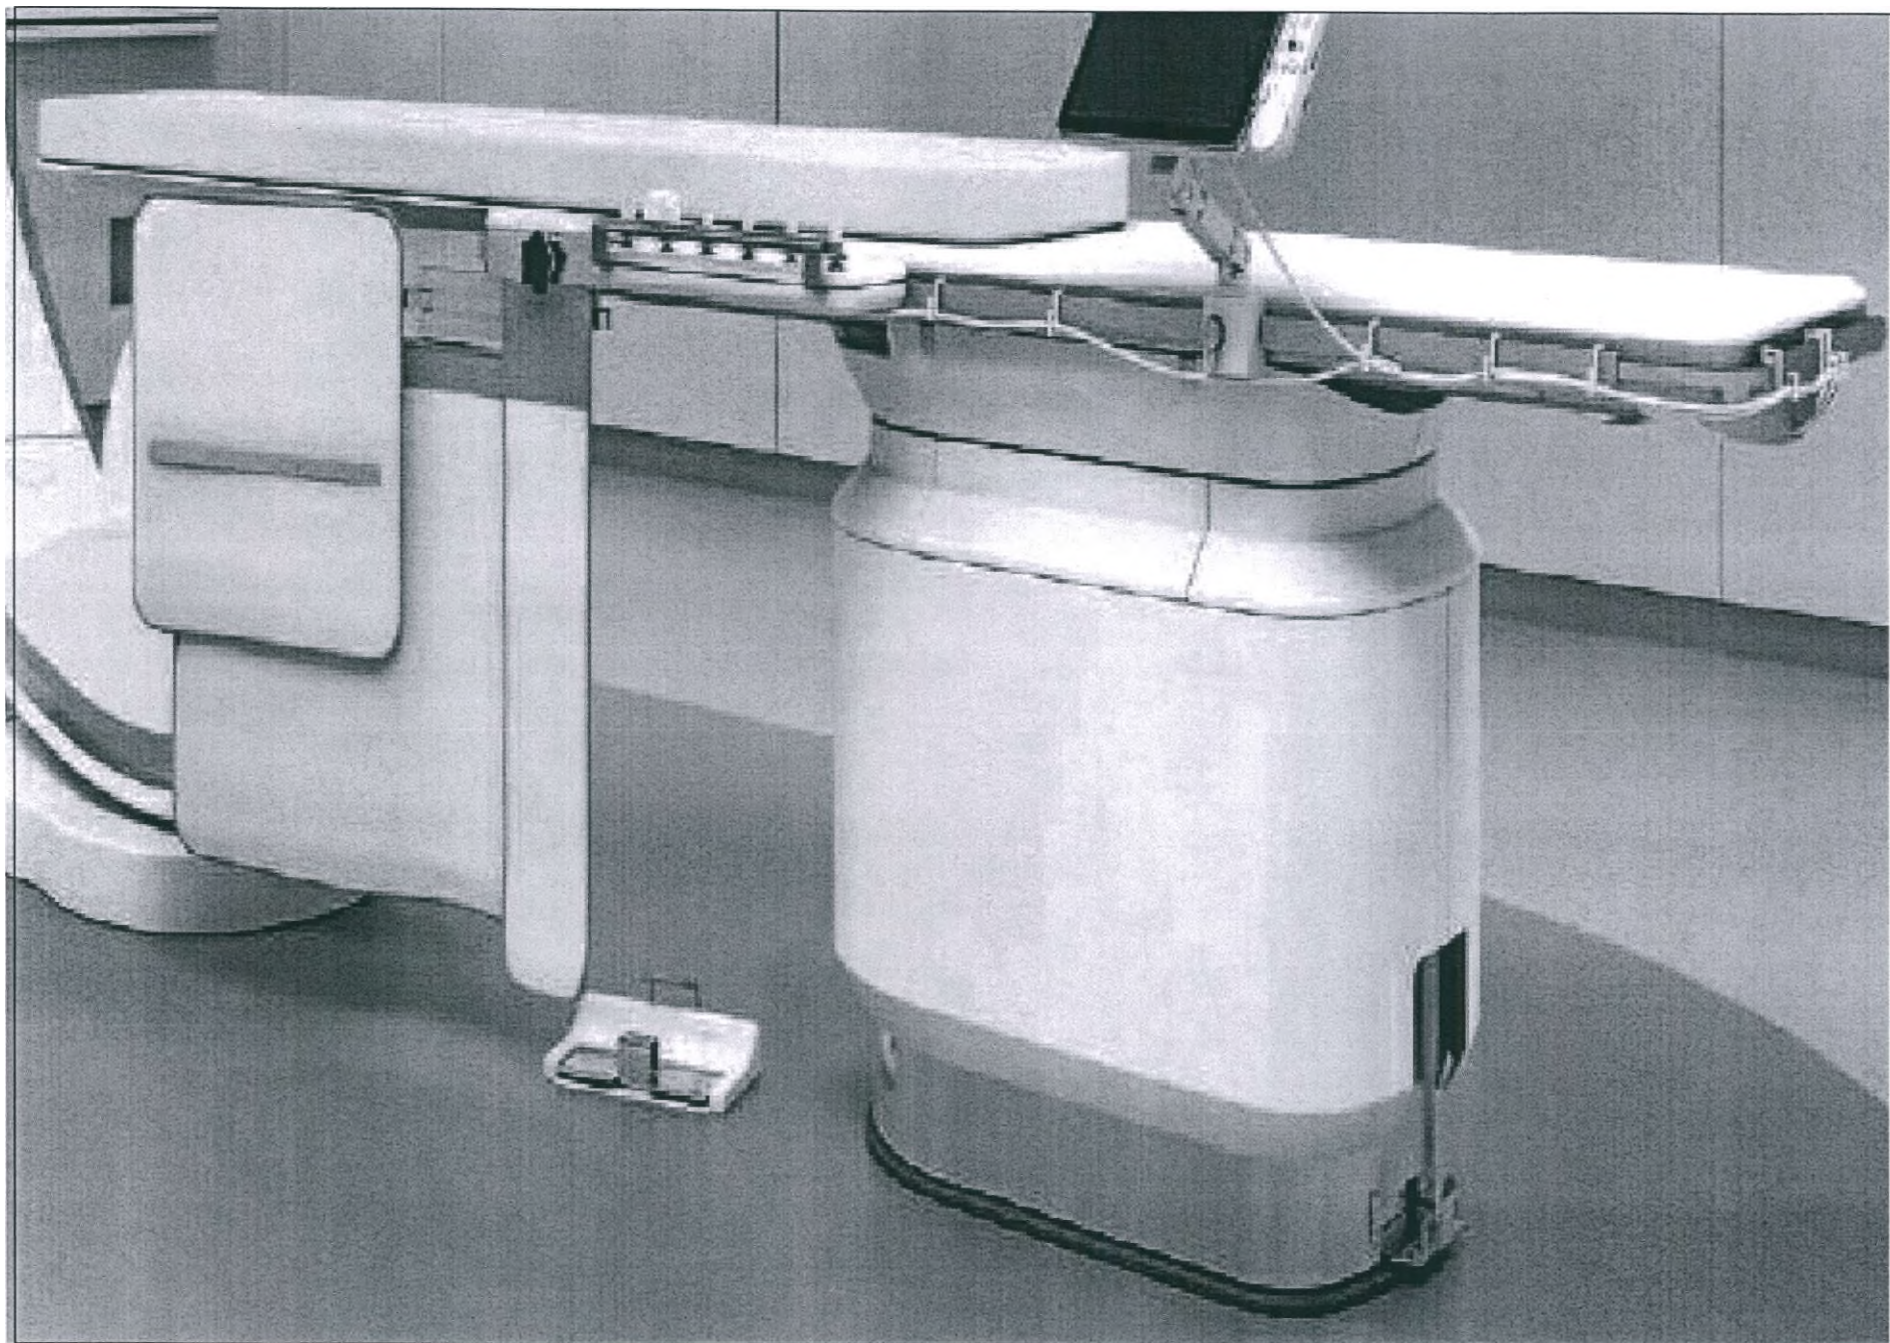


2.а. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

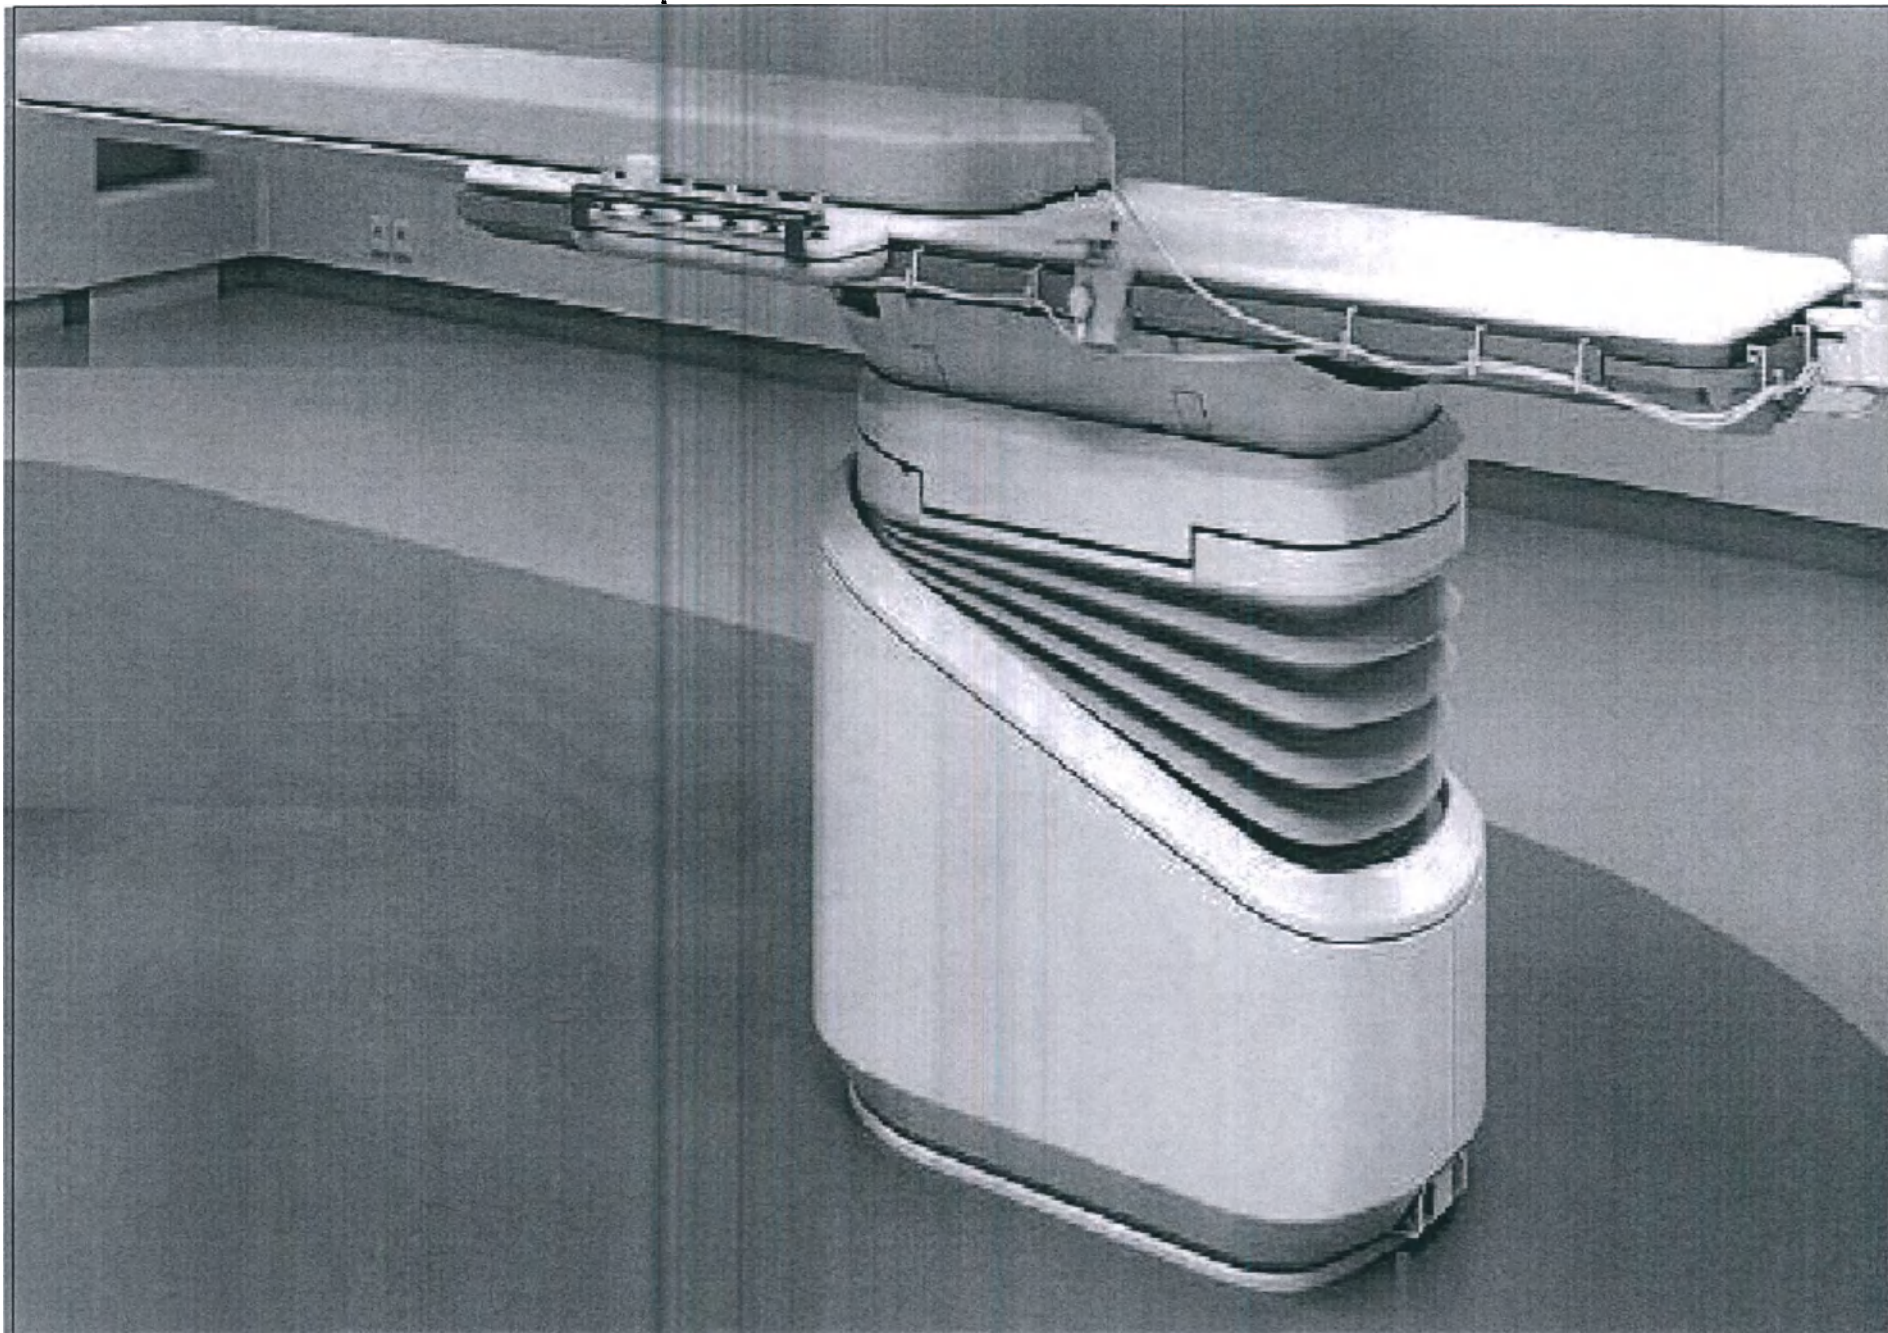


2.6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

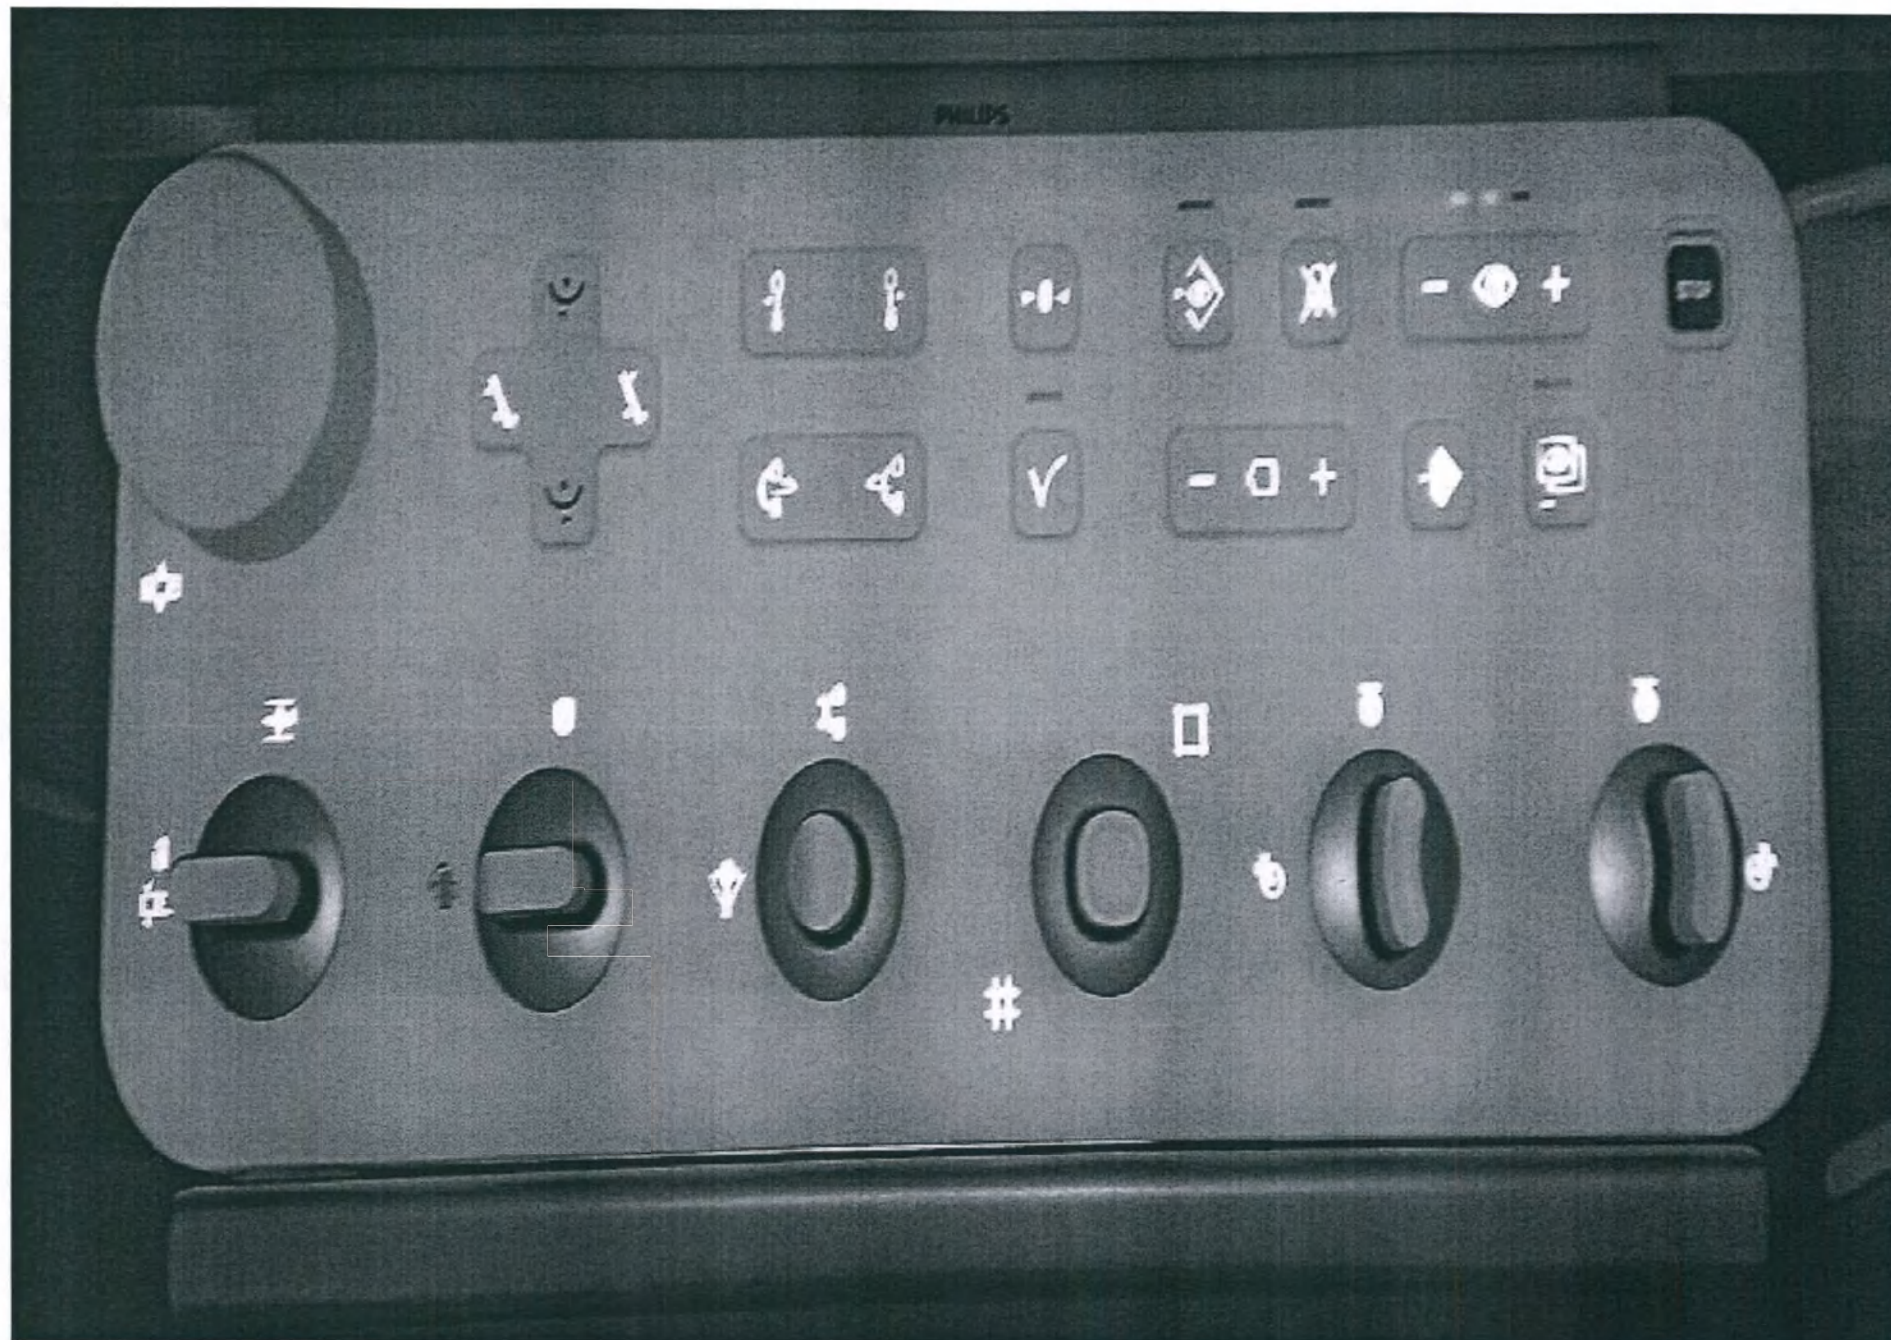

3. Модуль управления, не более 4 шт.

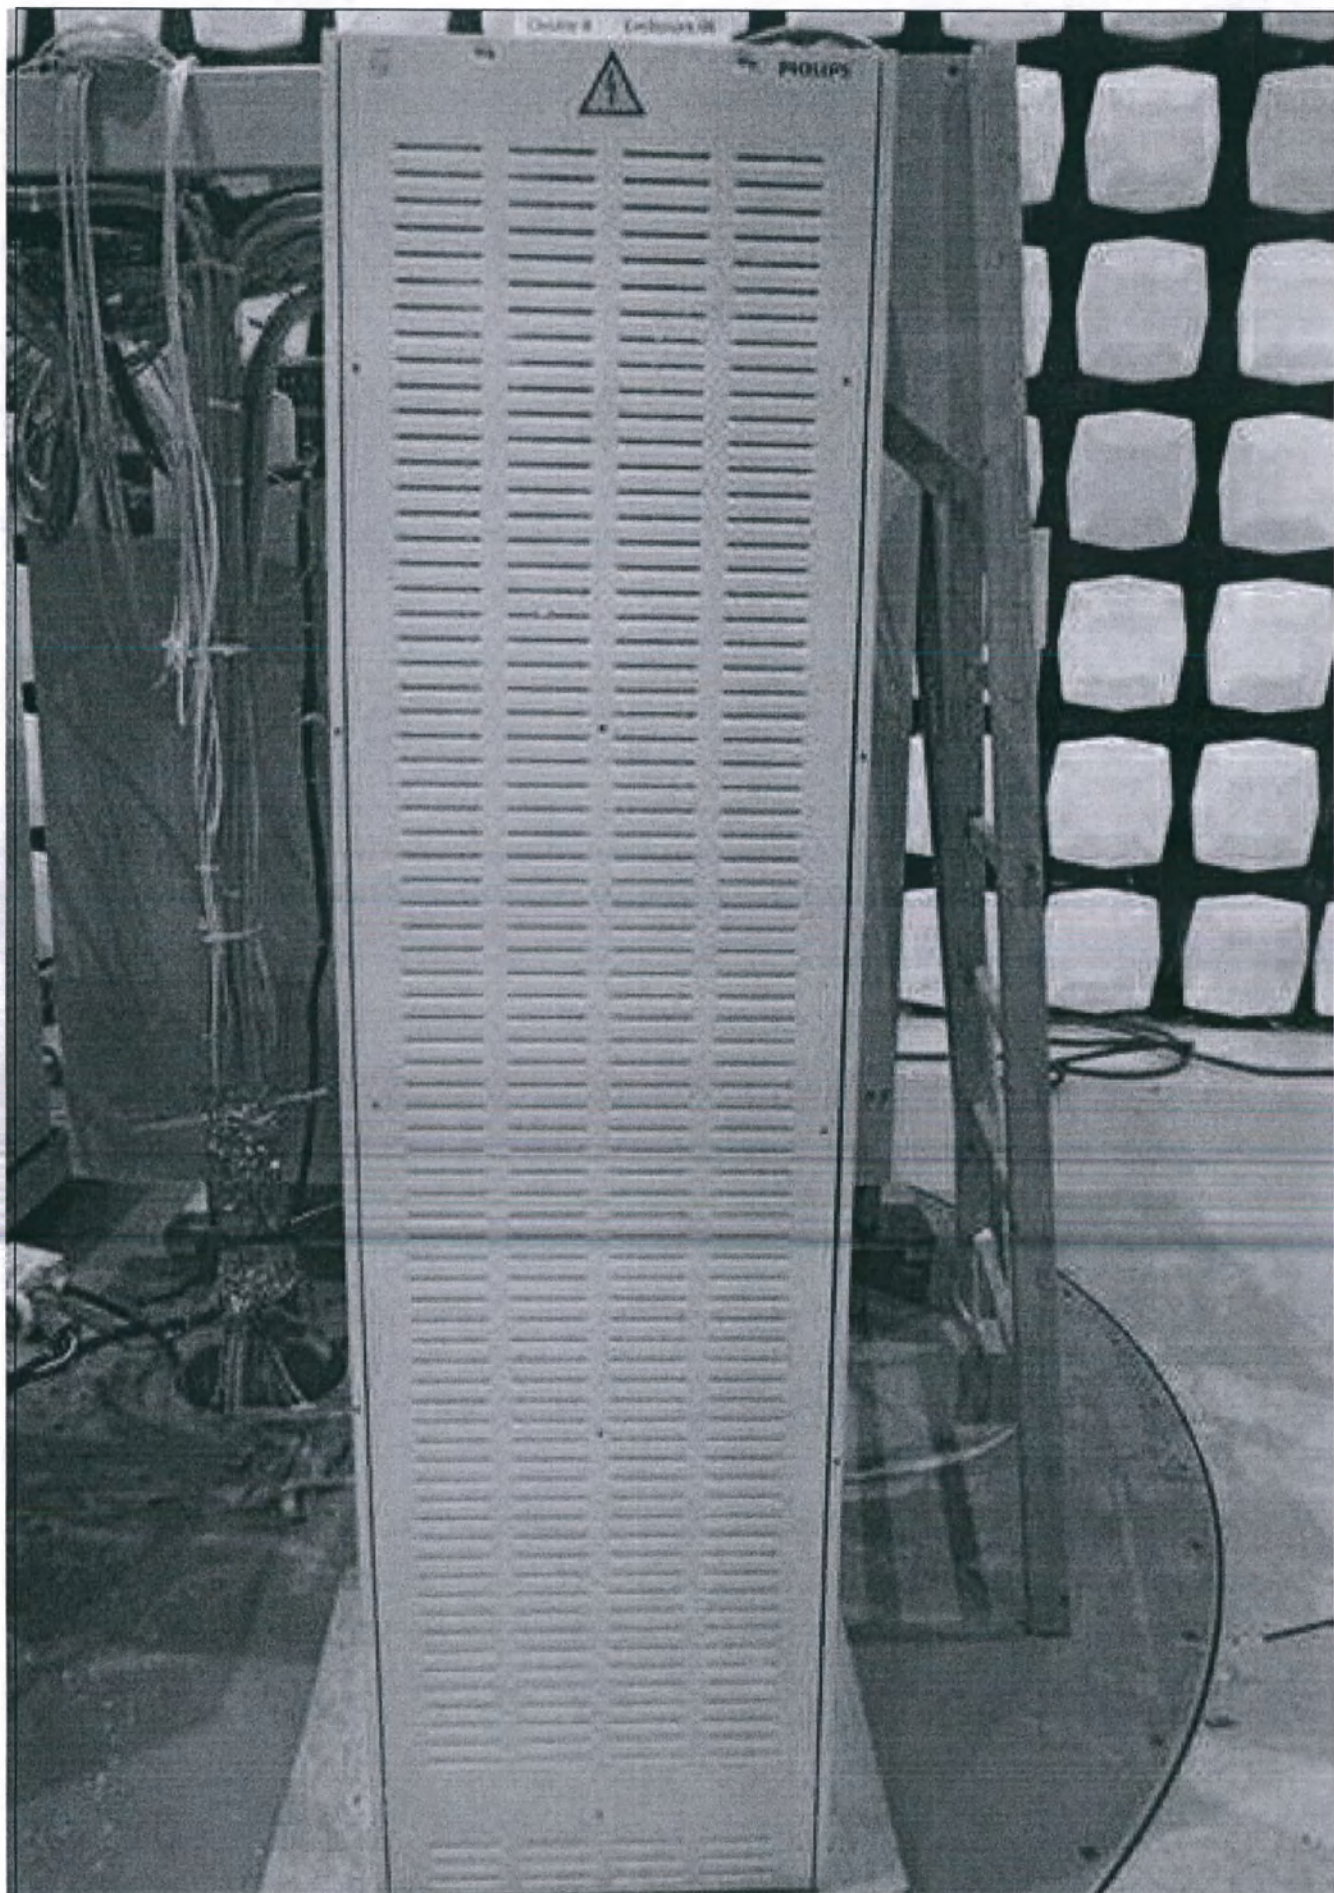



4.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

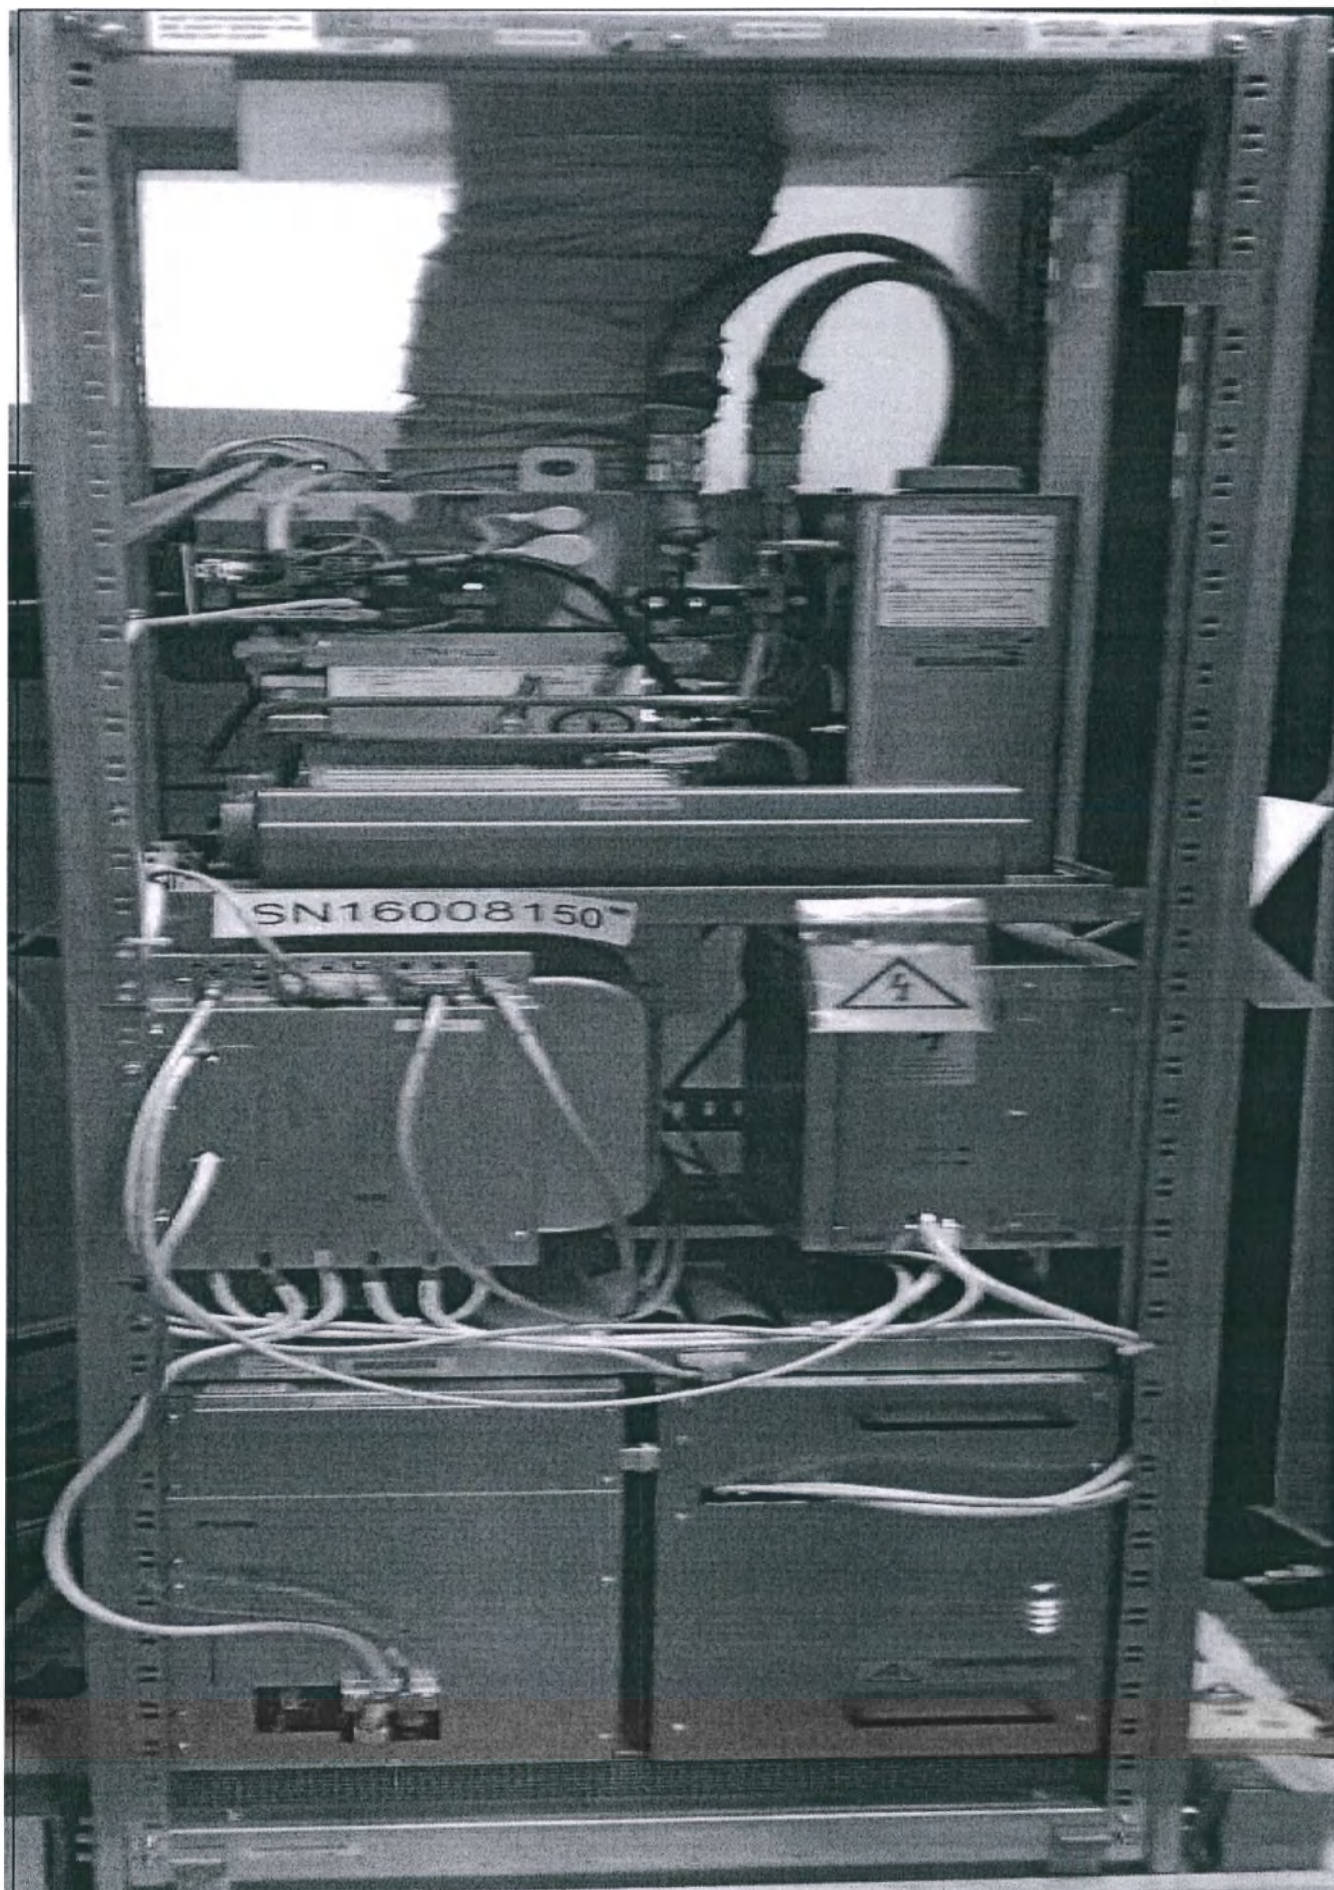


4.6. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

5.а. Шкаф управления.

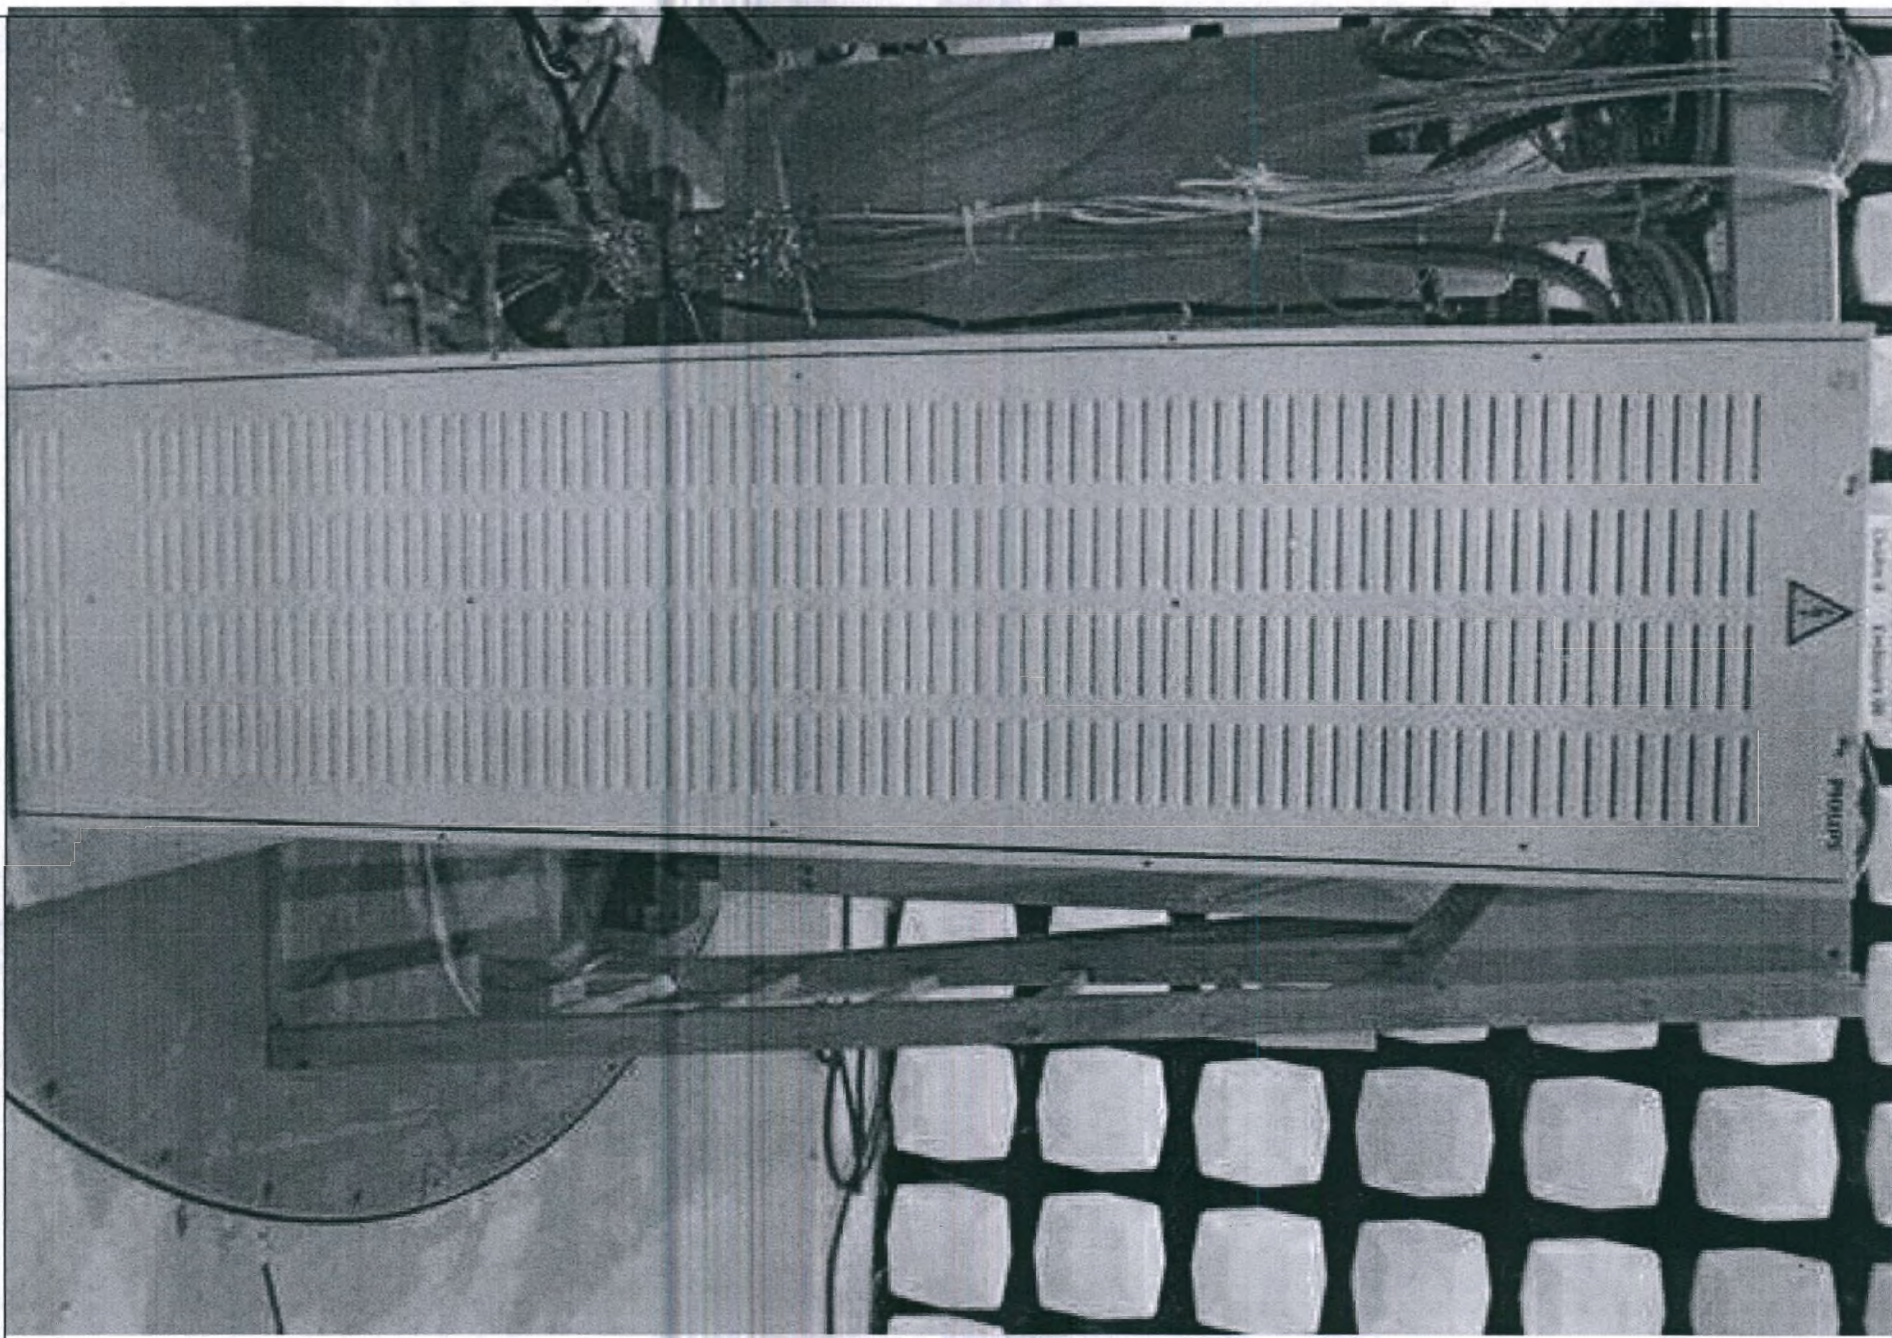

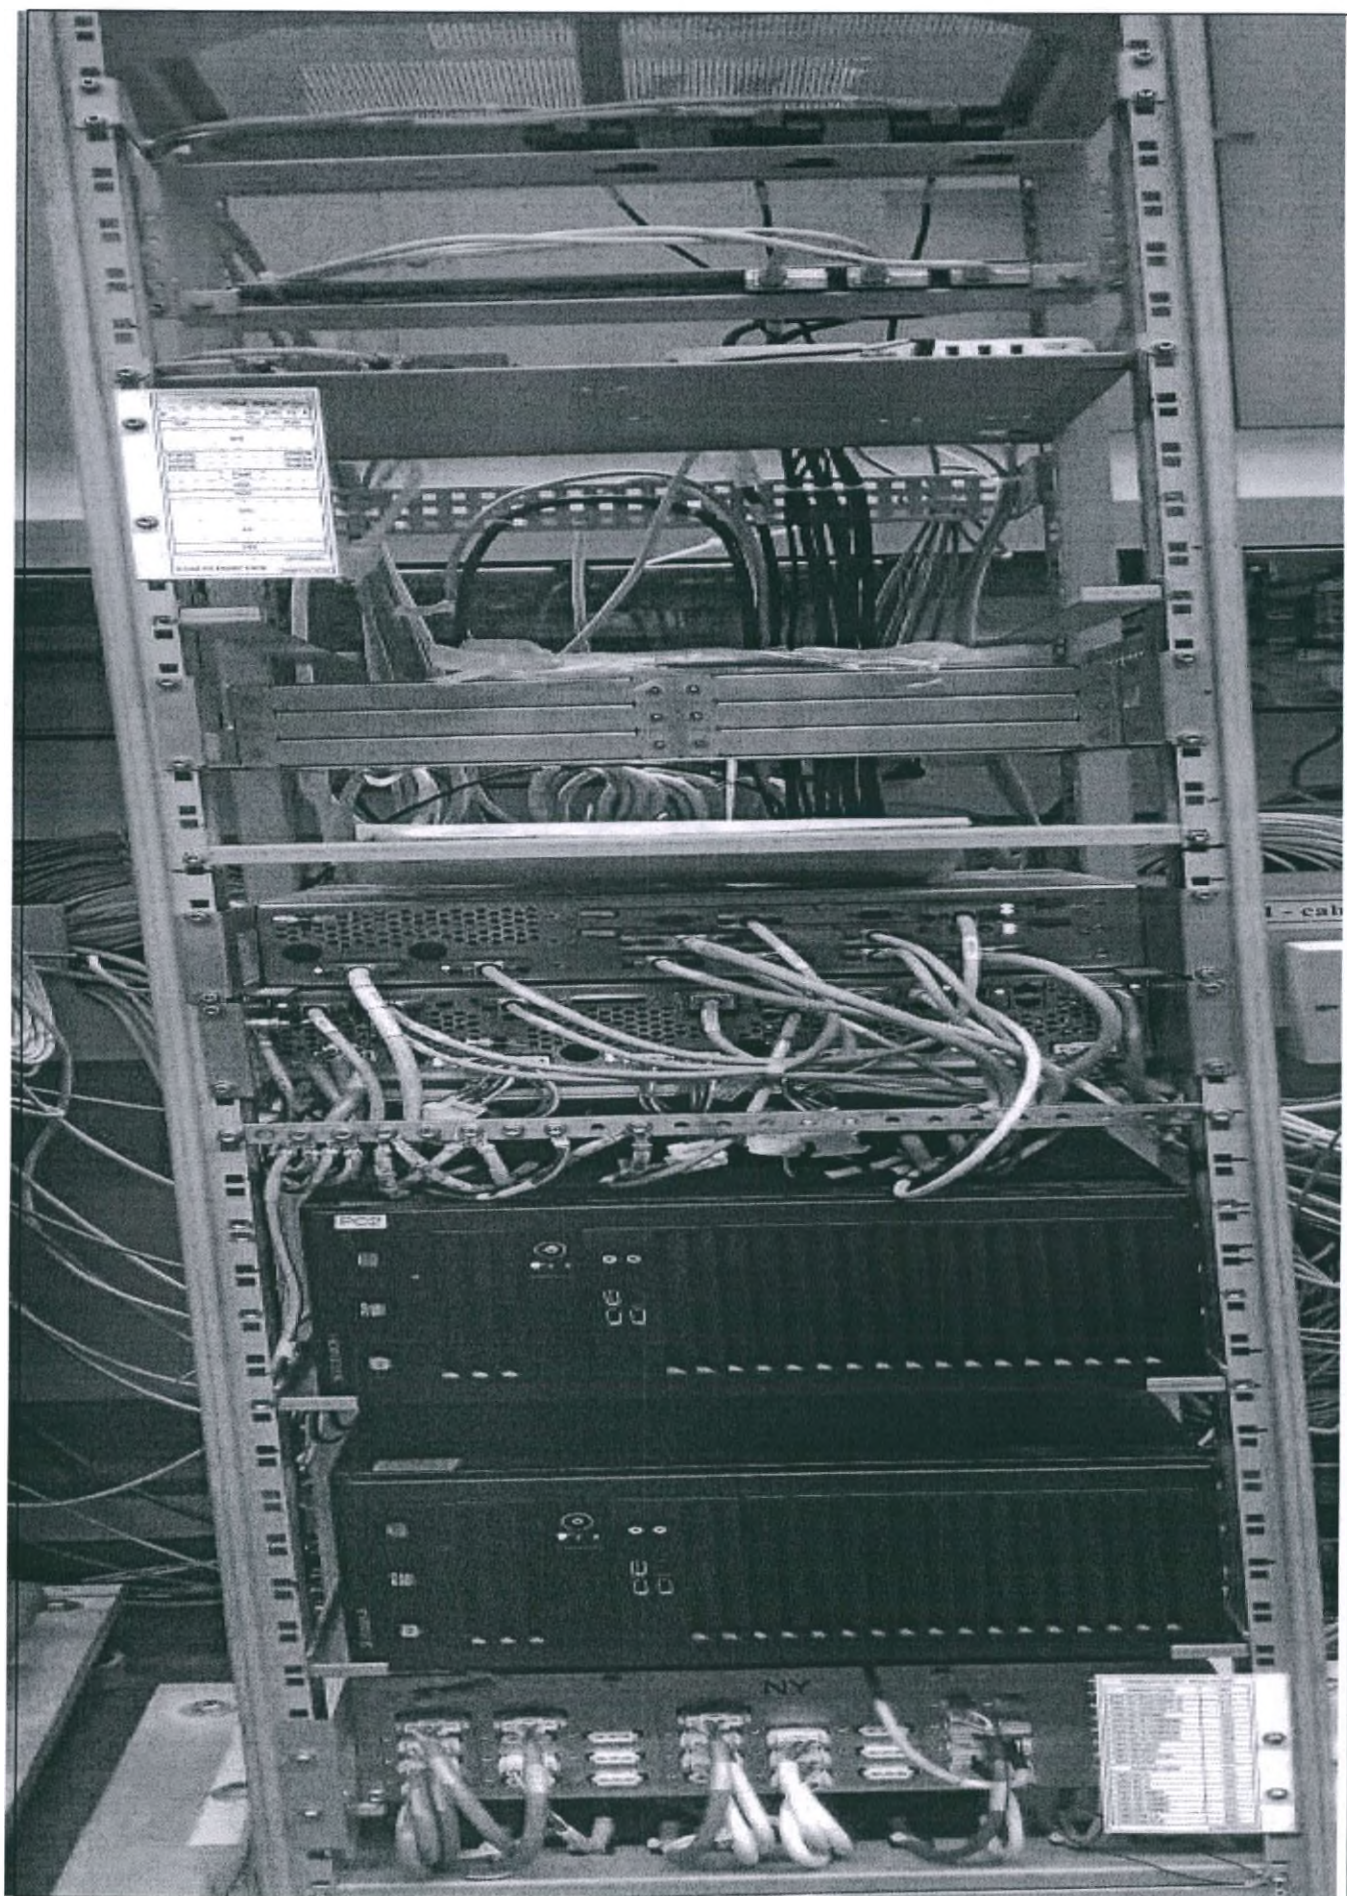


5.6. Шкаф управления.

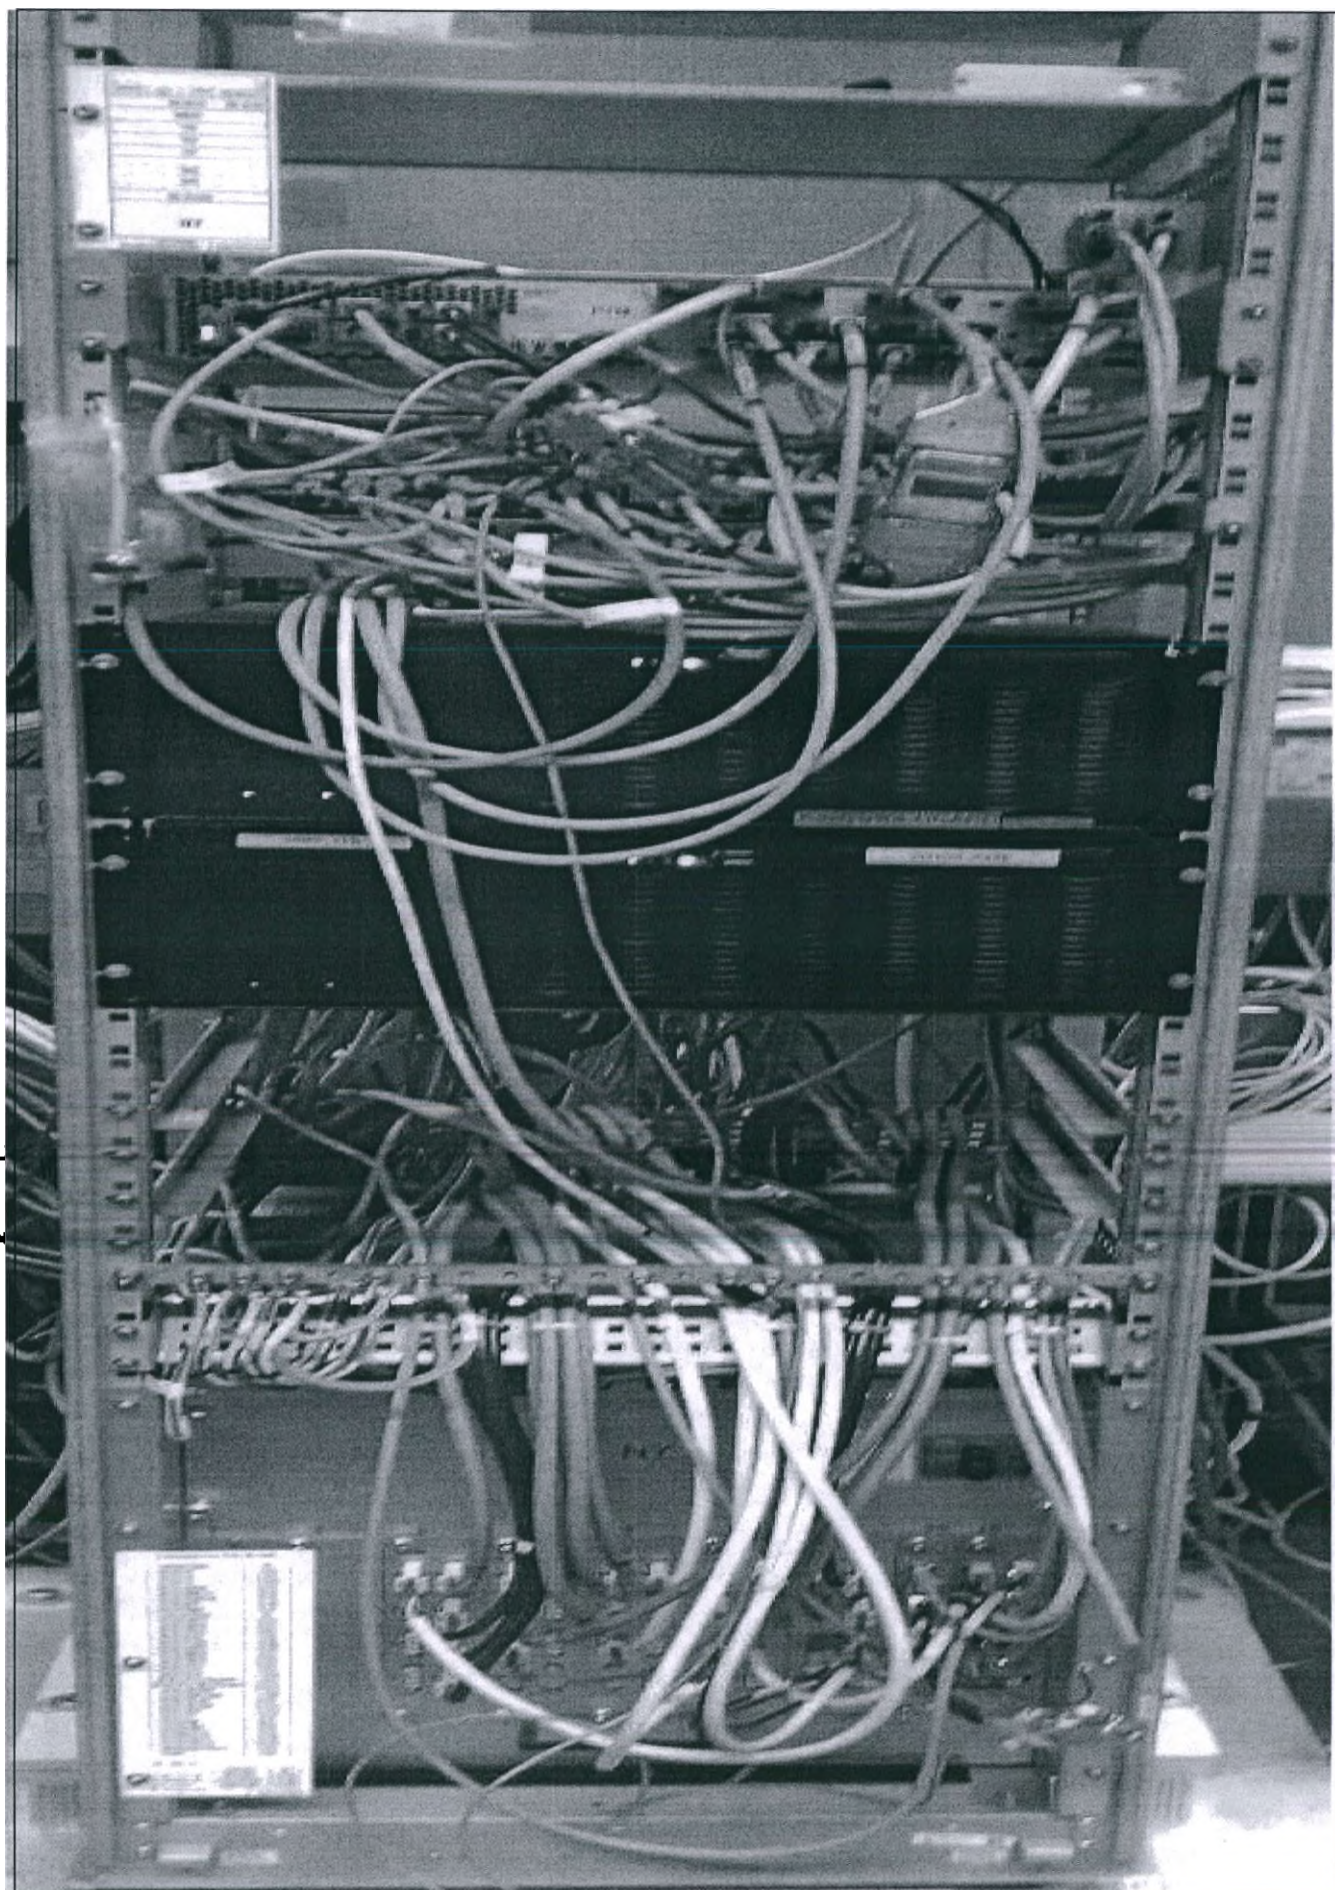


б.а. Распределительный щит.

6.6. Распределительный щит.

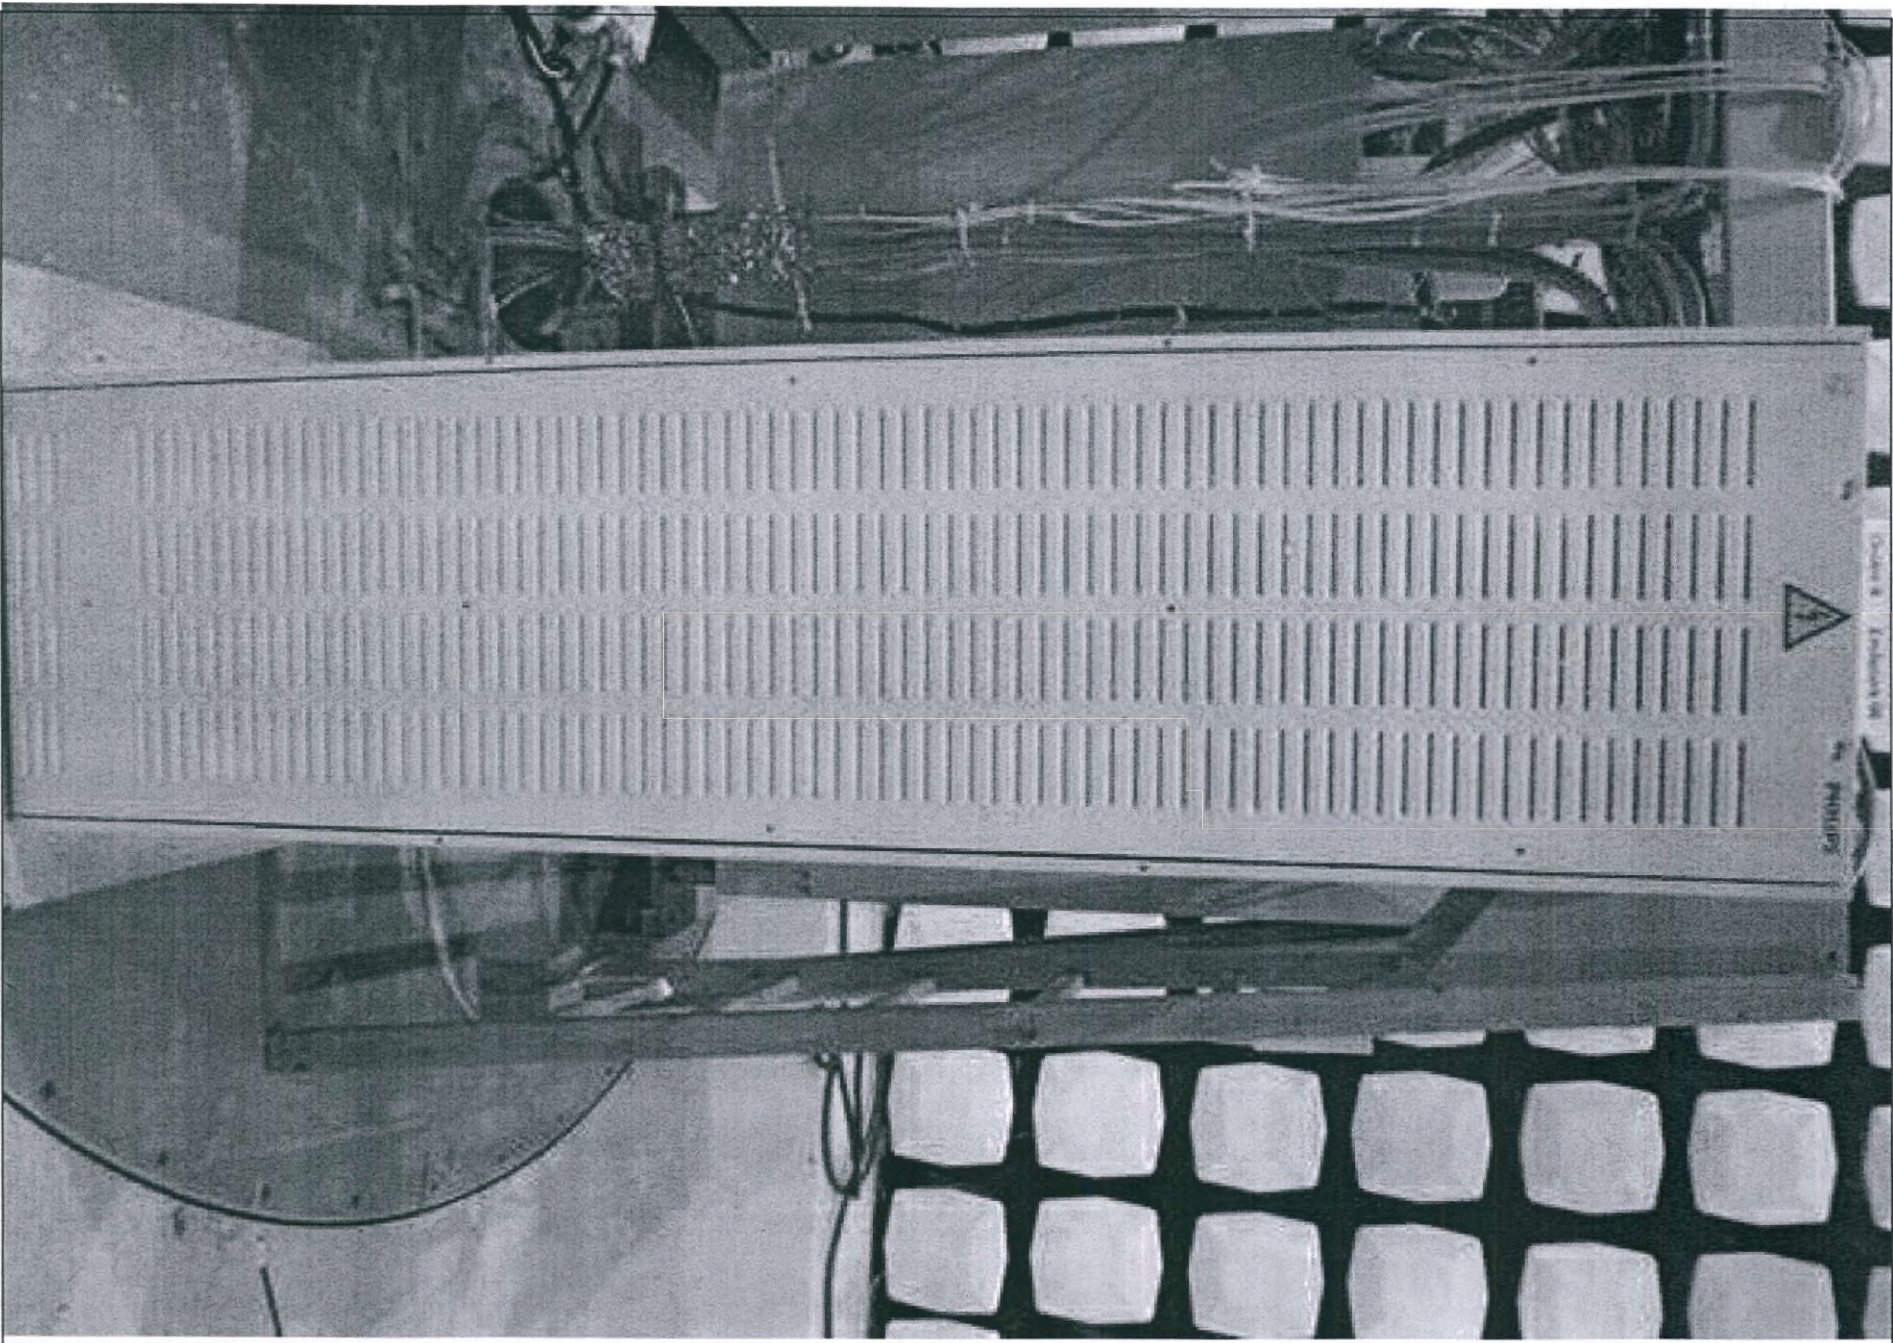





7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

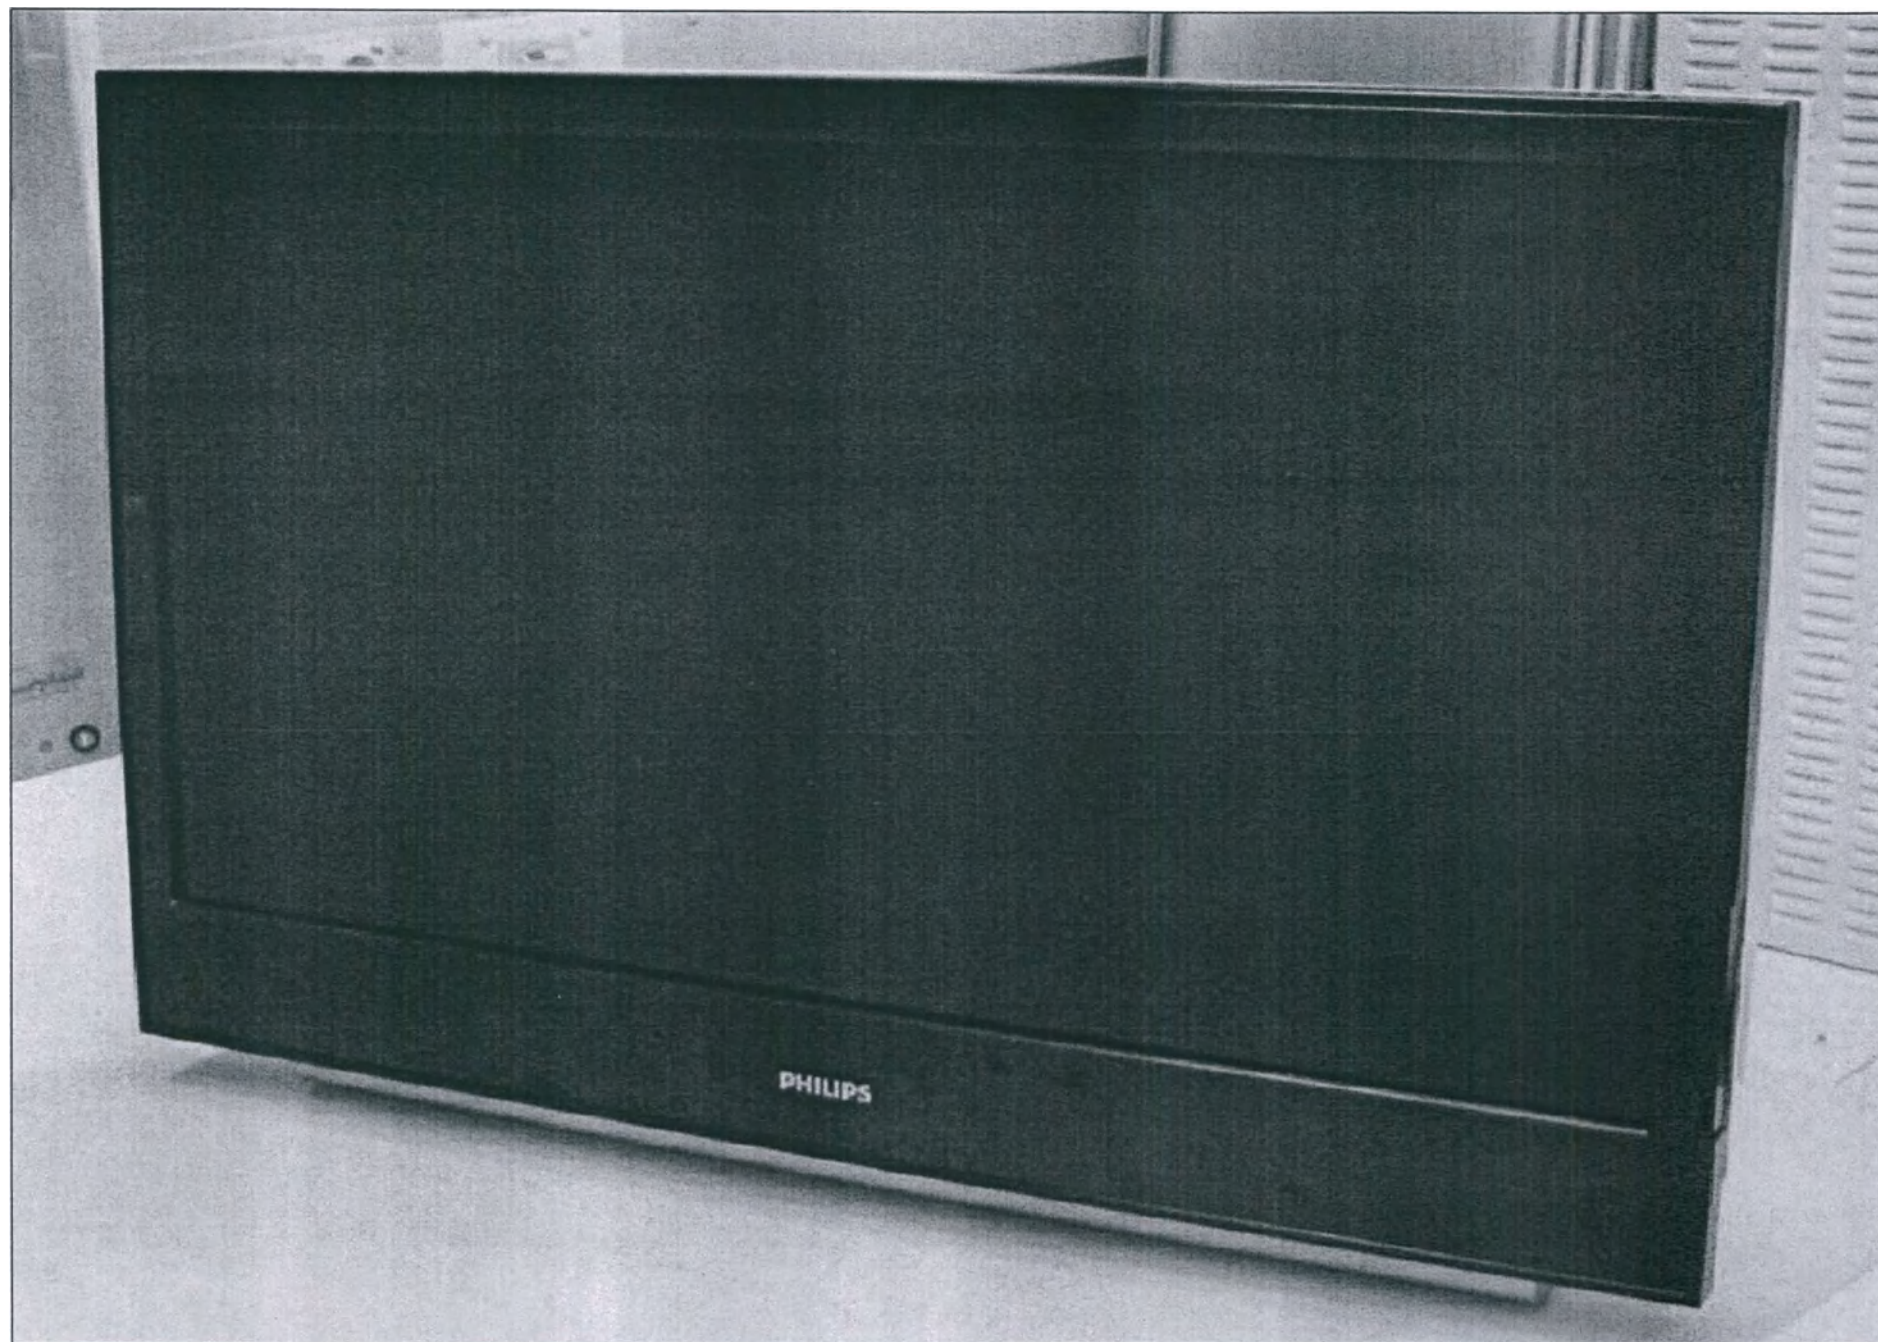

8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

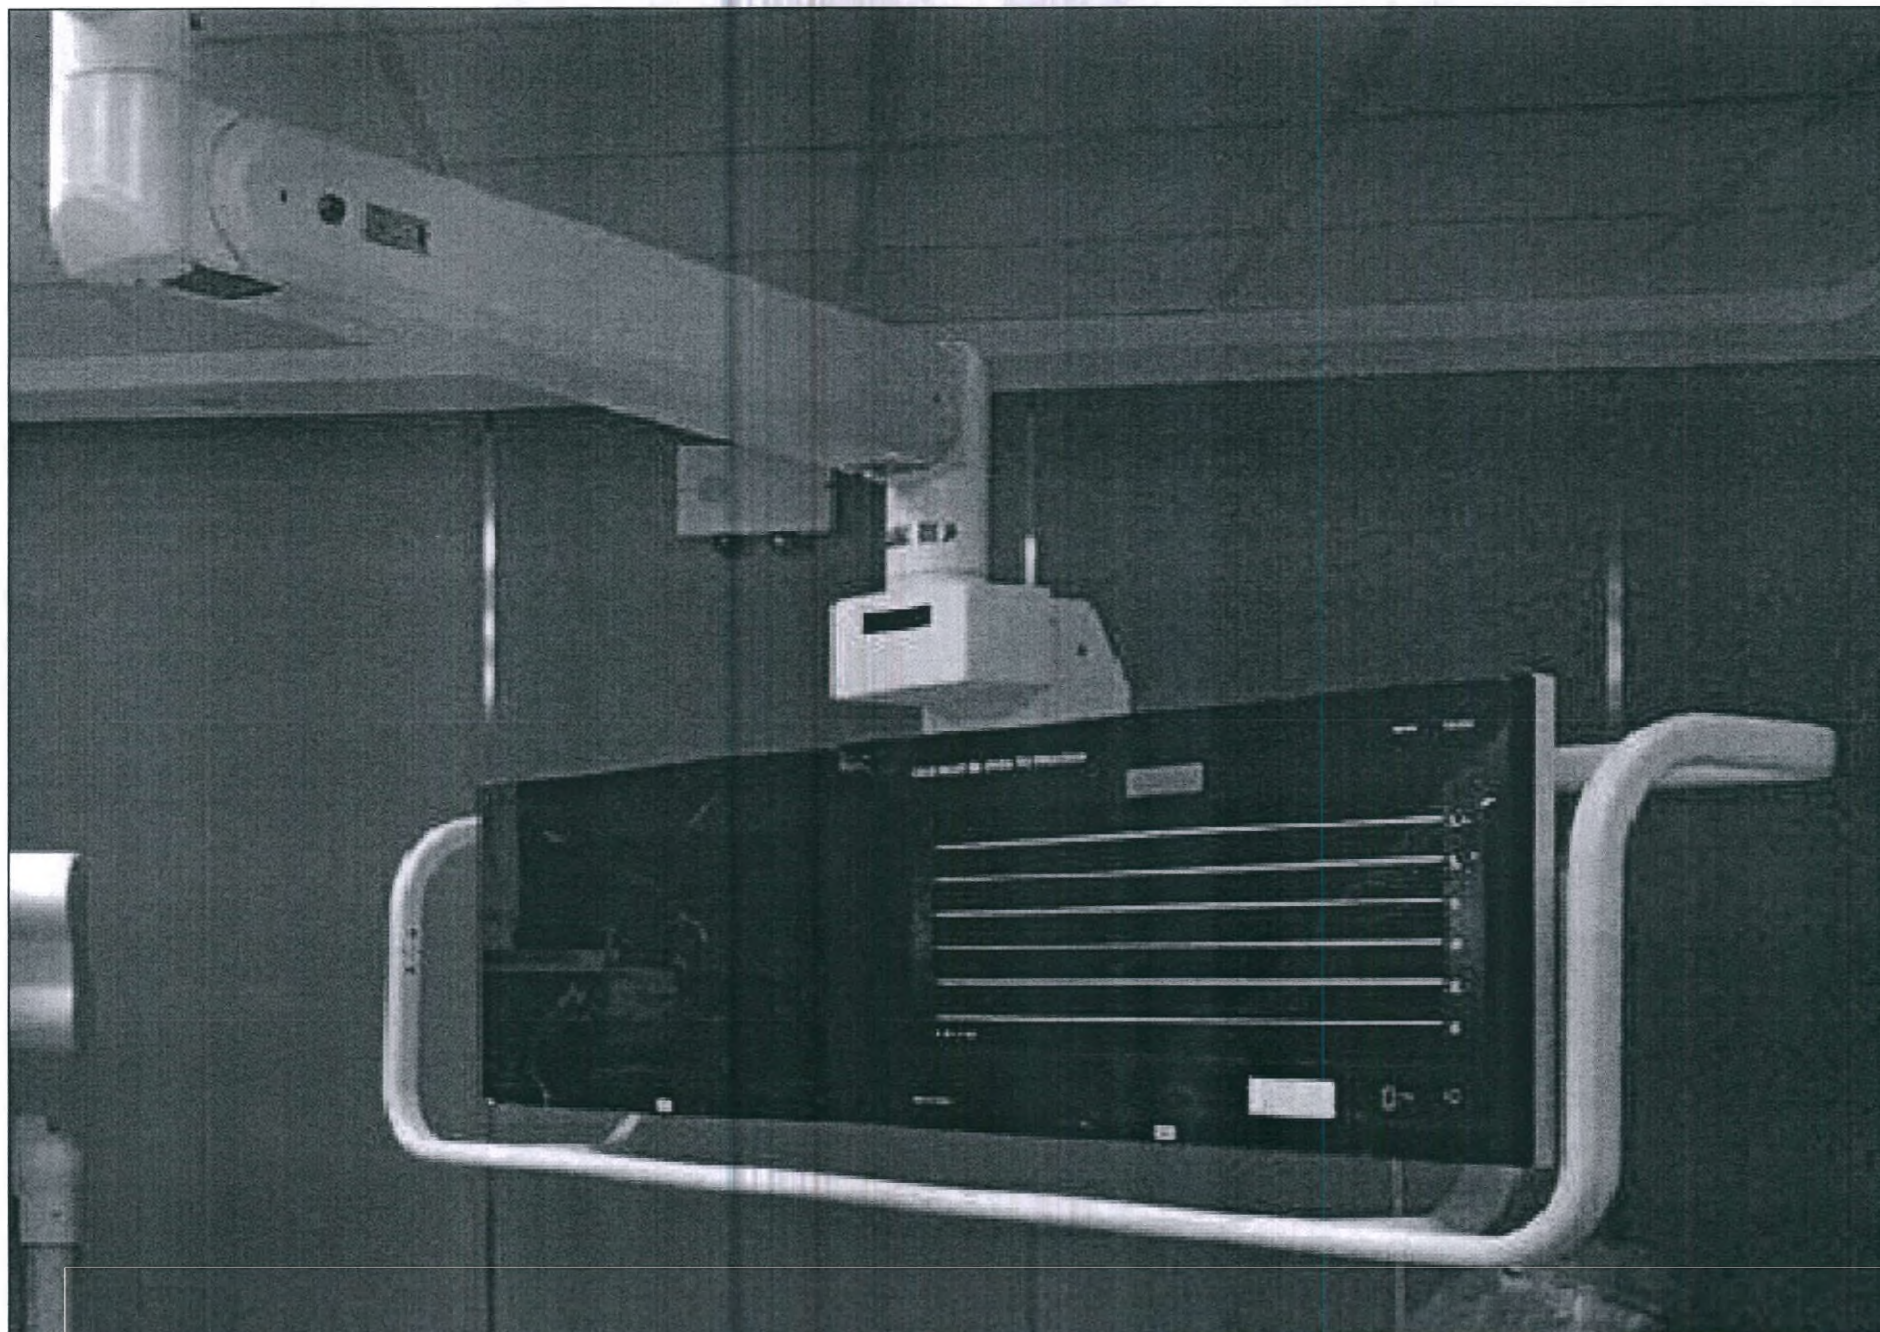


9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

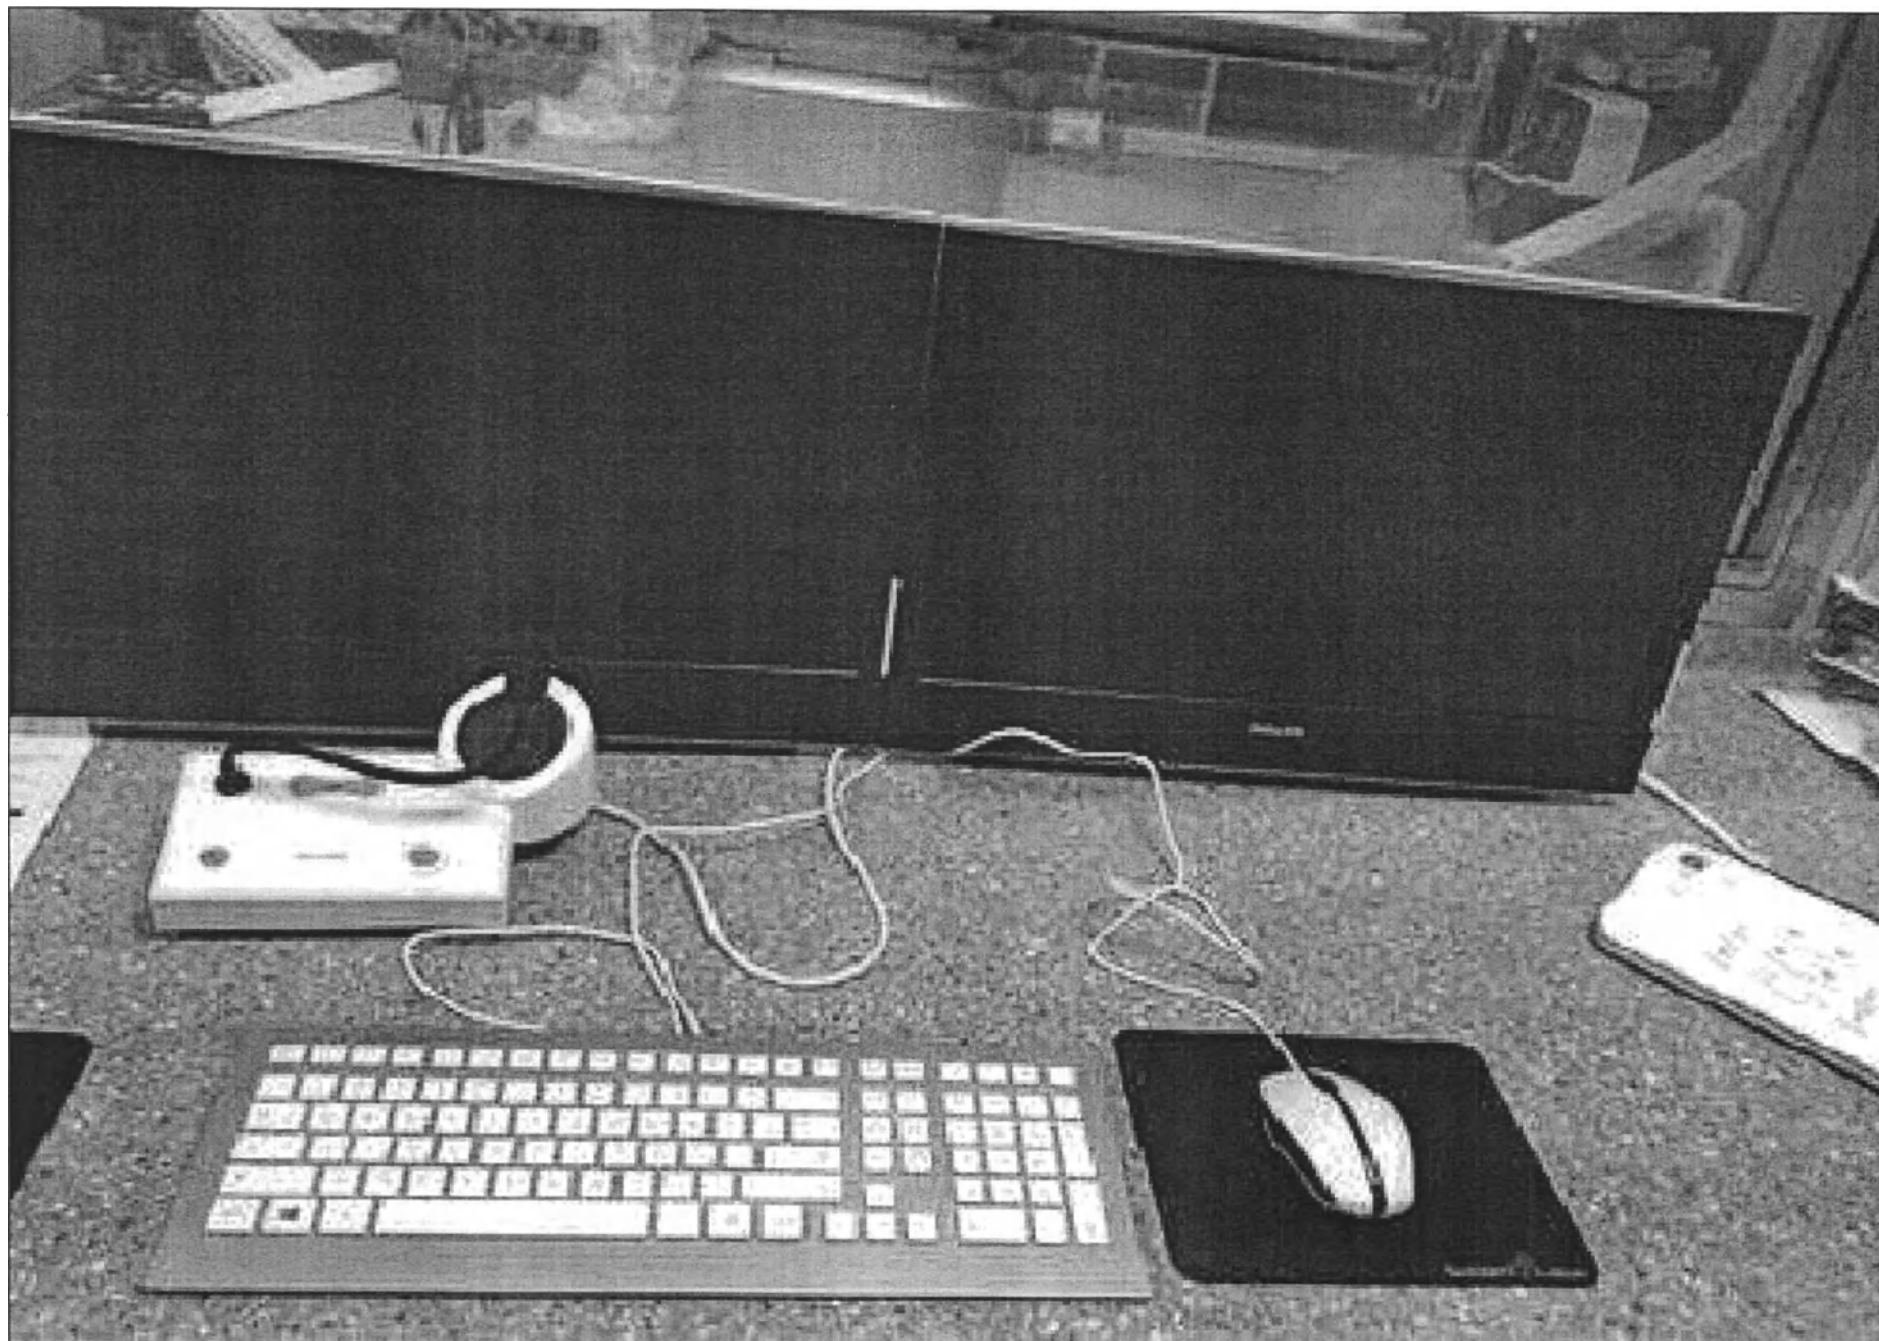


10.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.



10.6. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

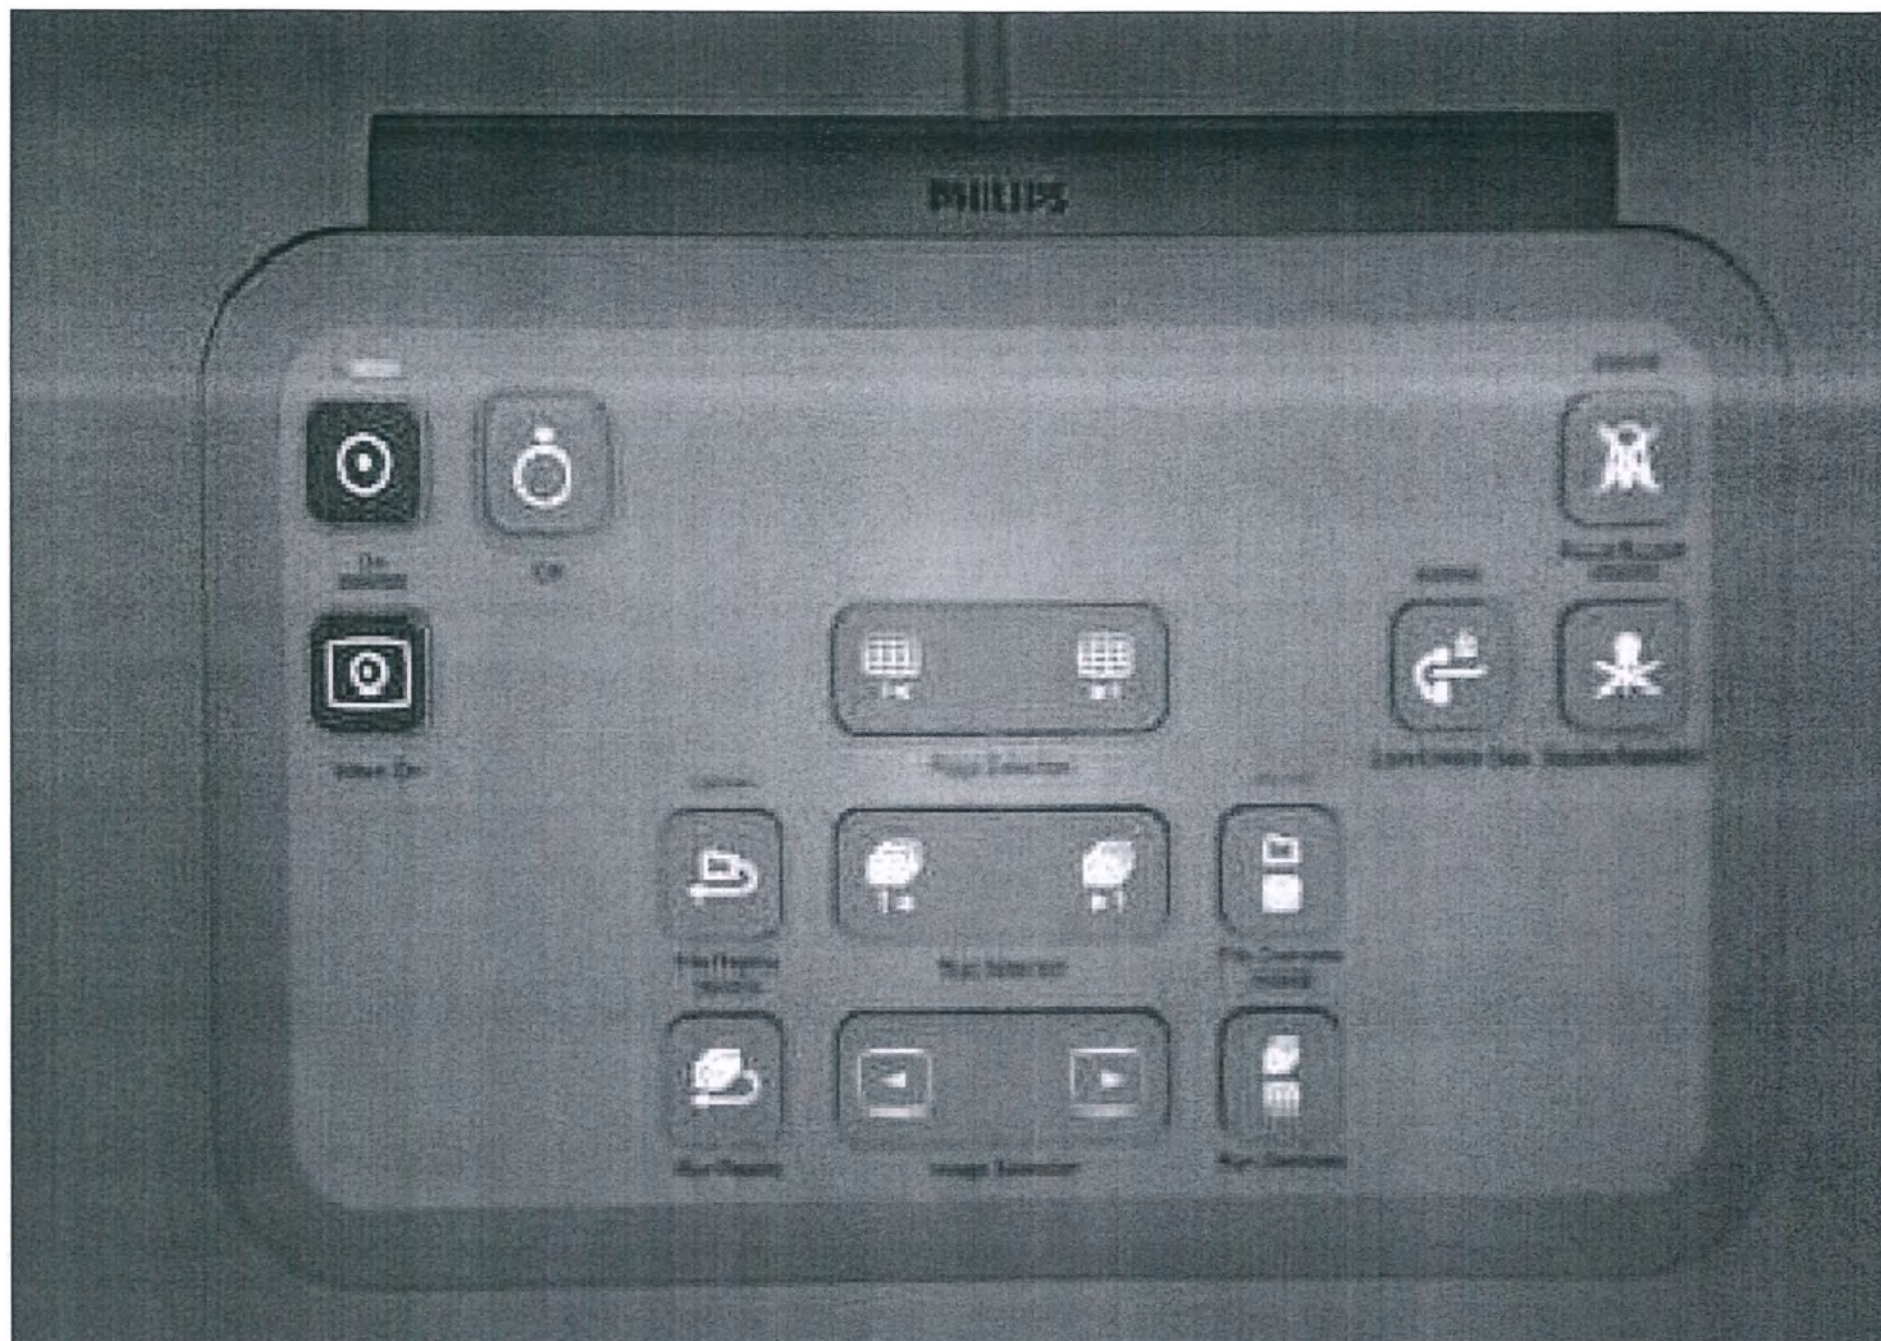


10.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

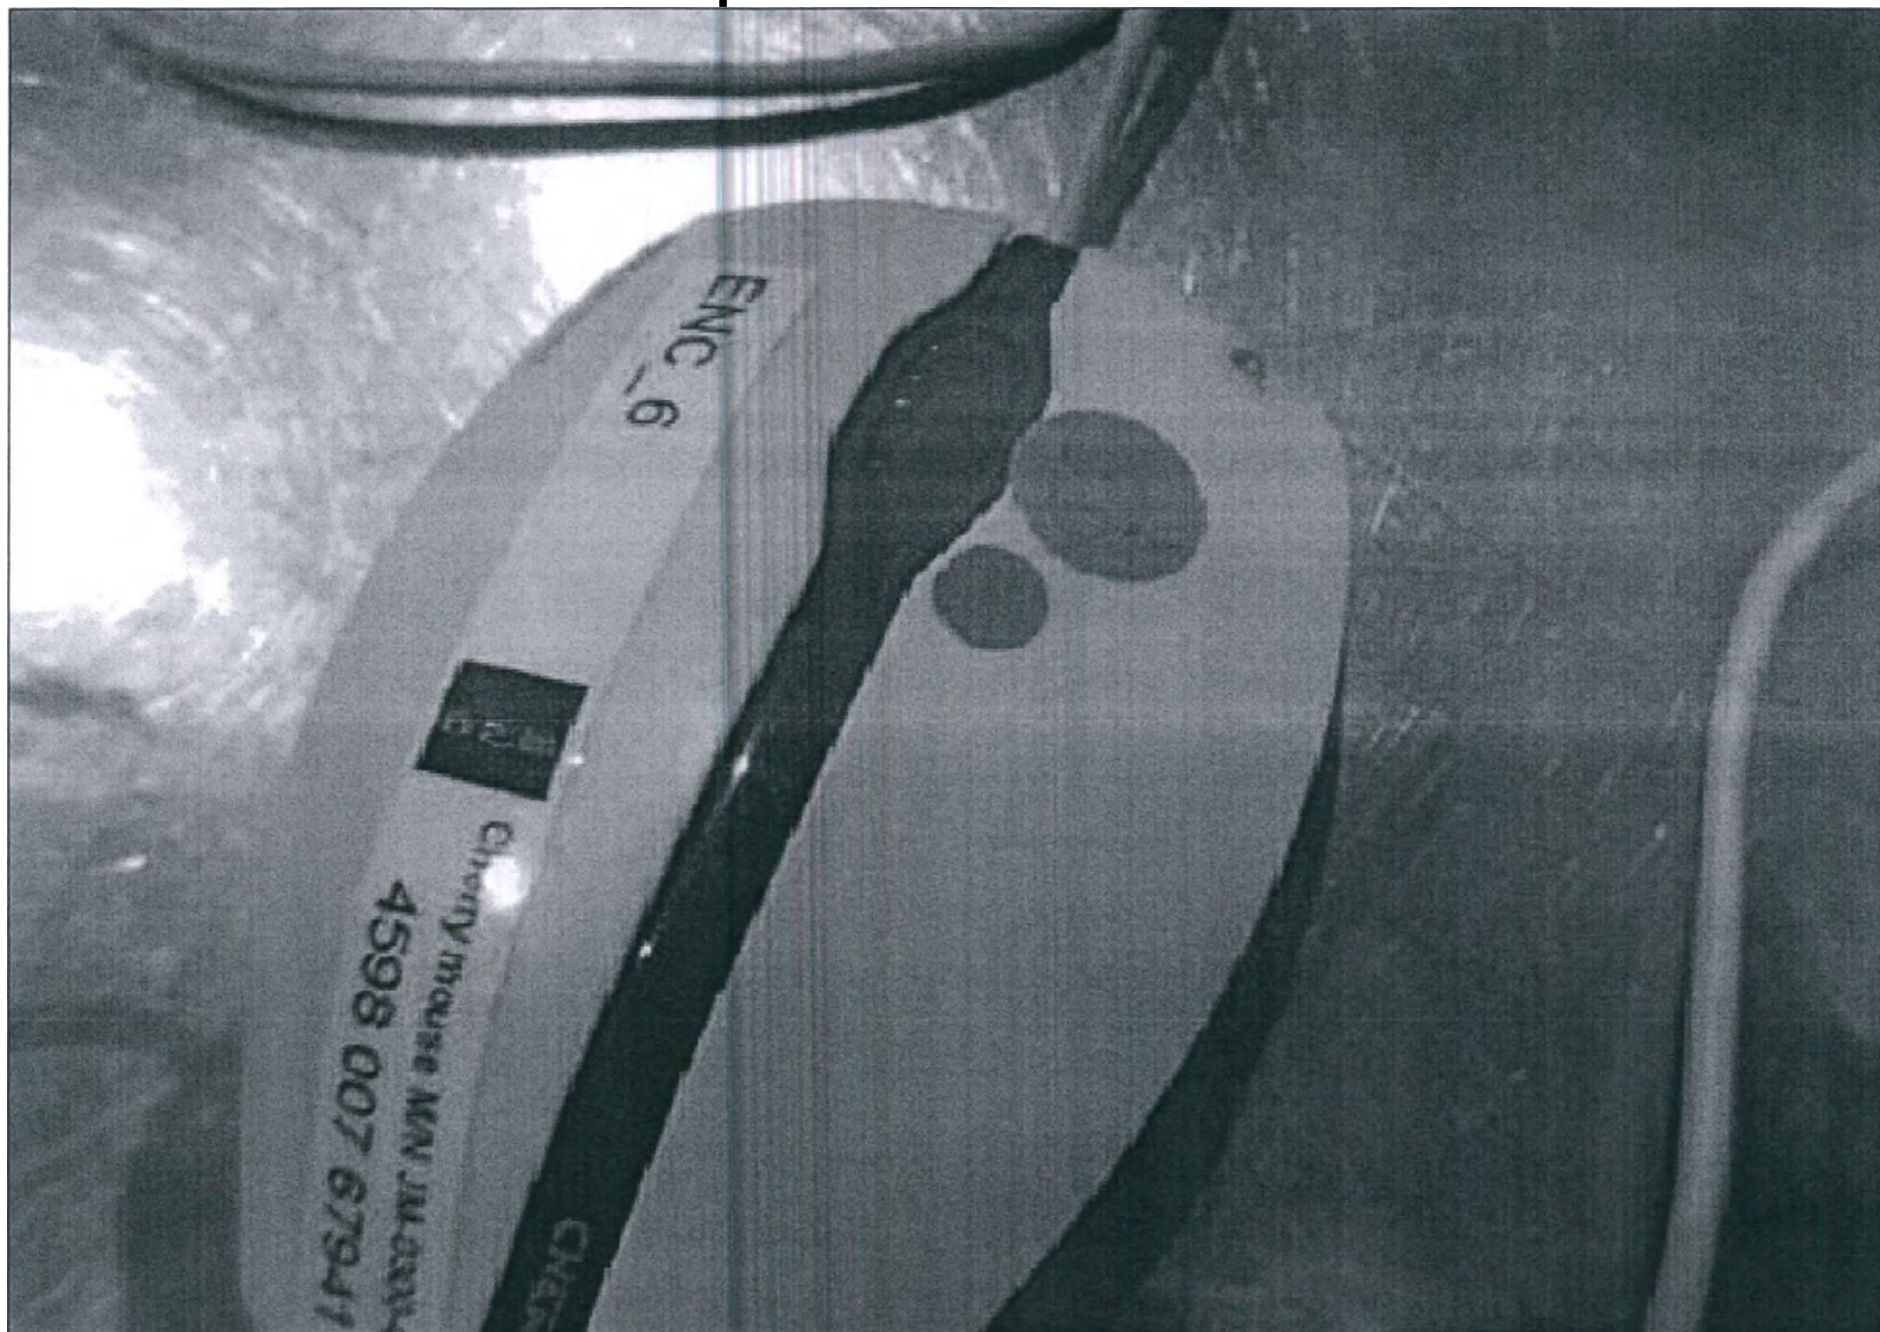


10.2. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.




10.д. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

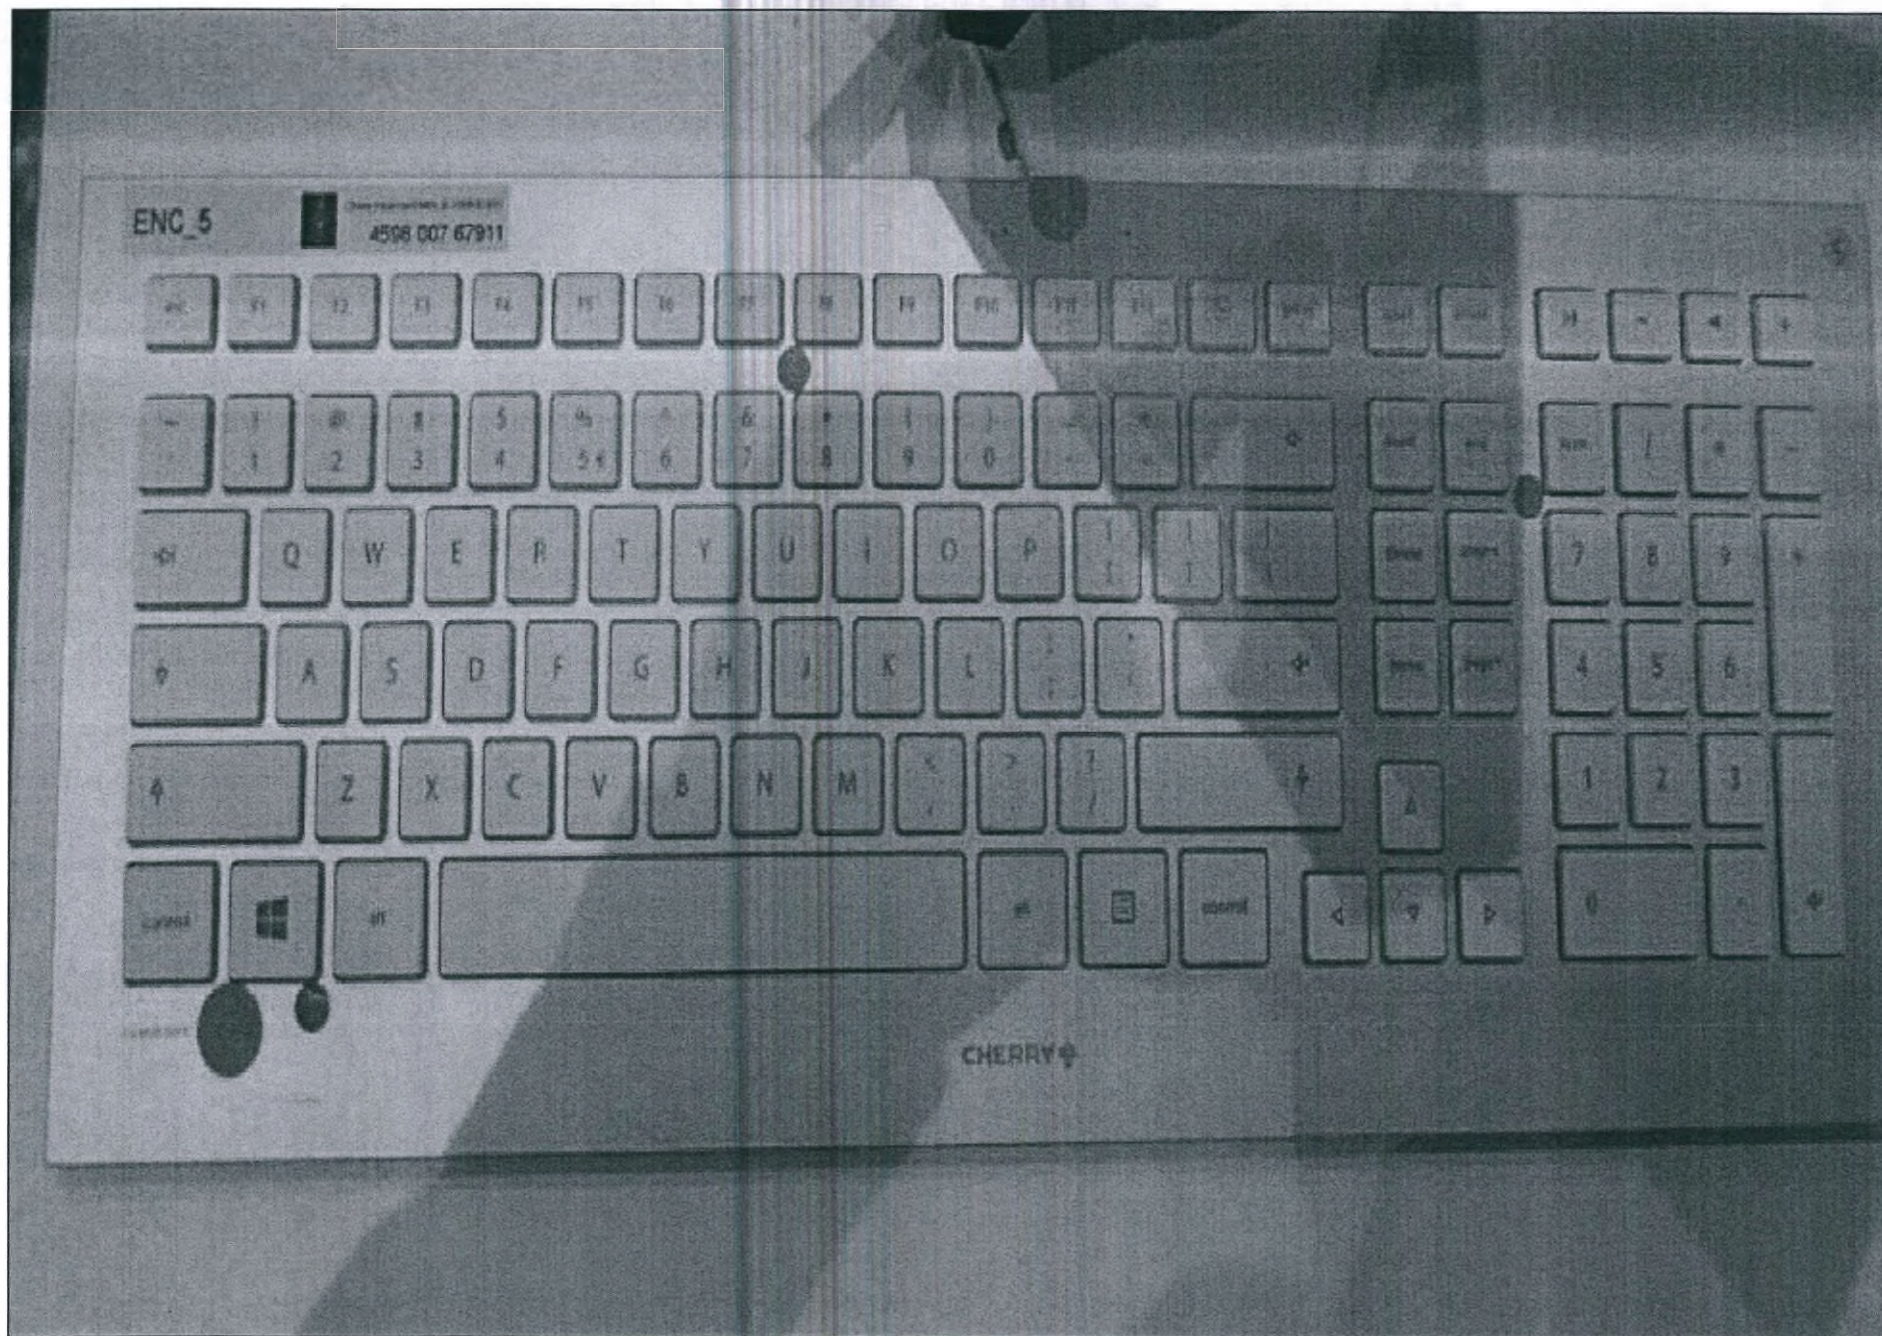


10.e. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

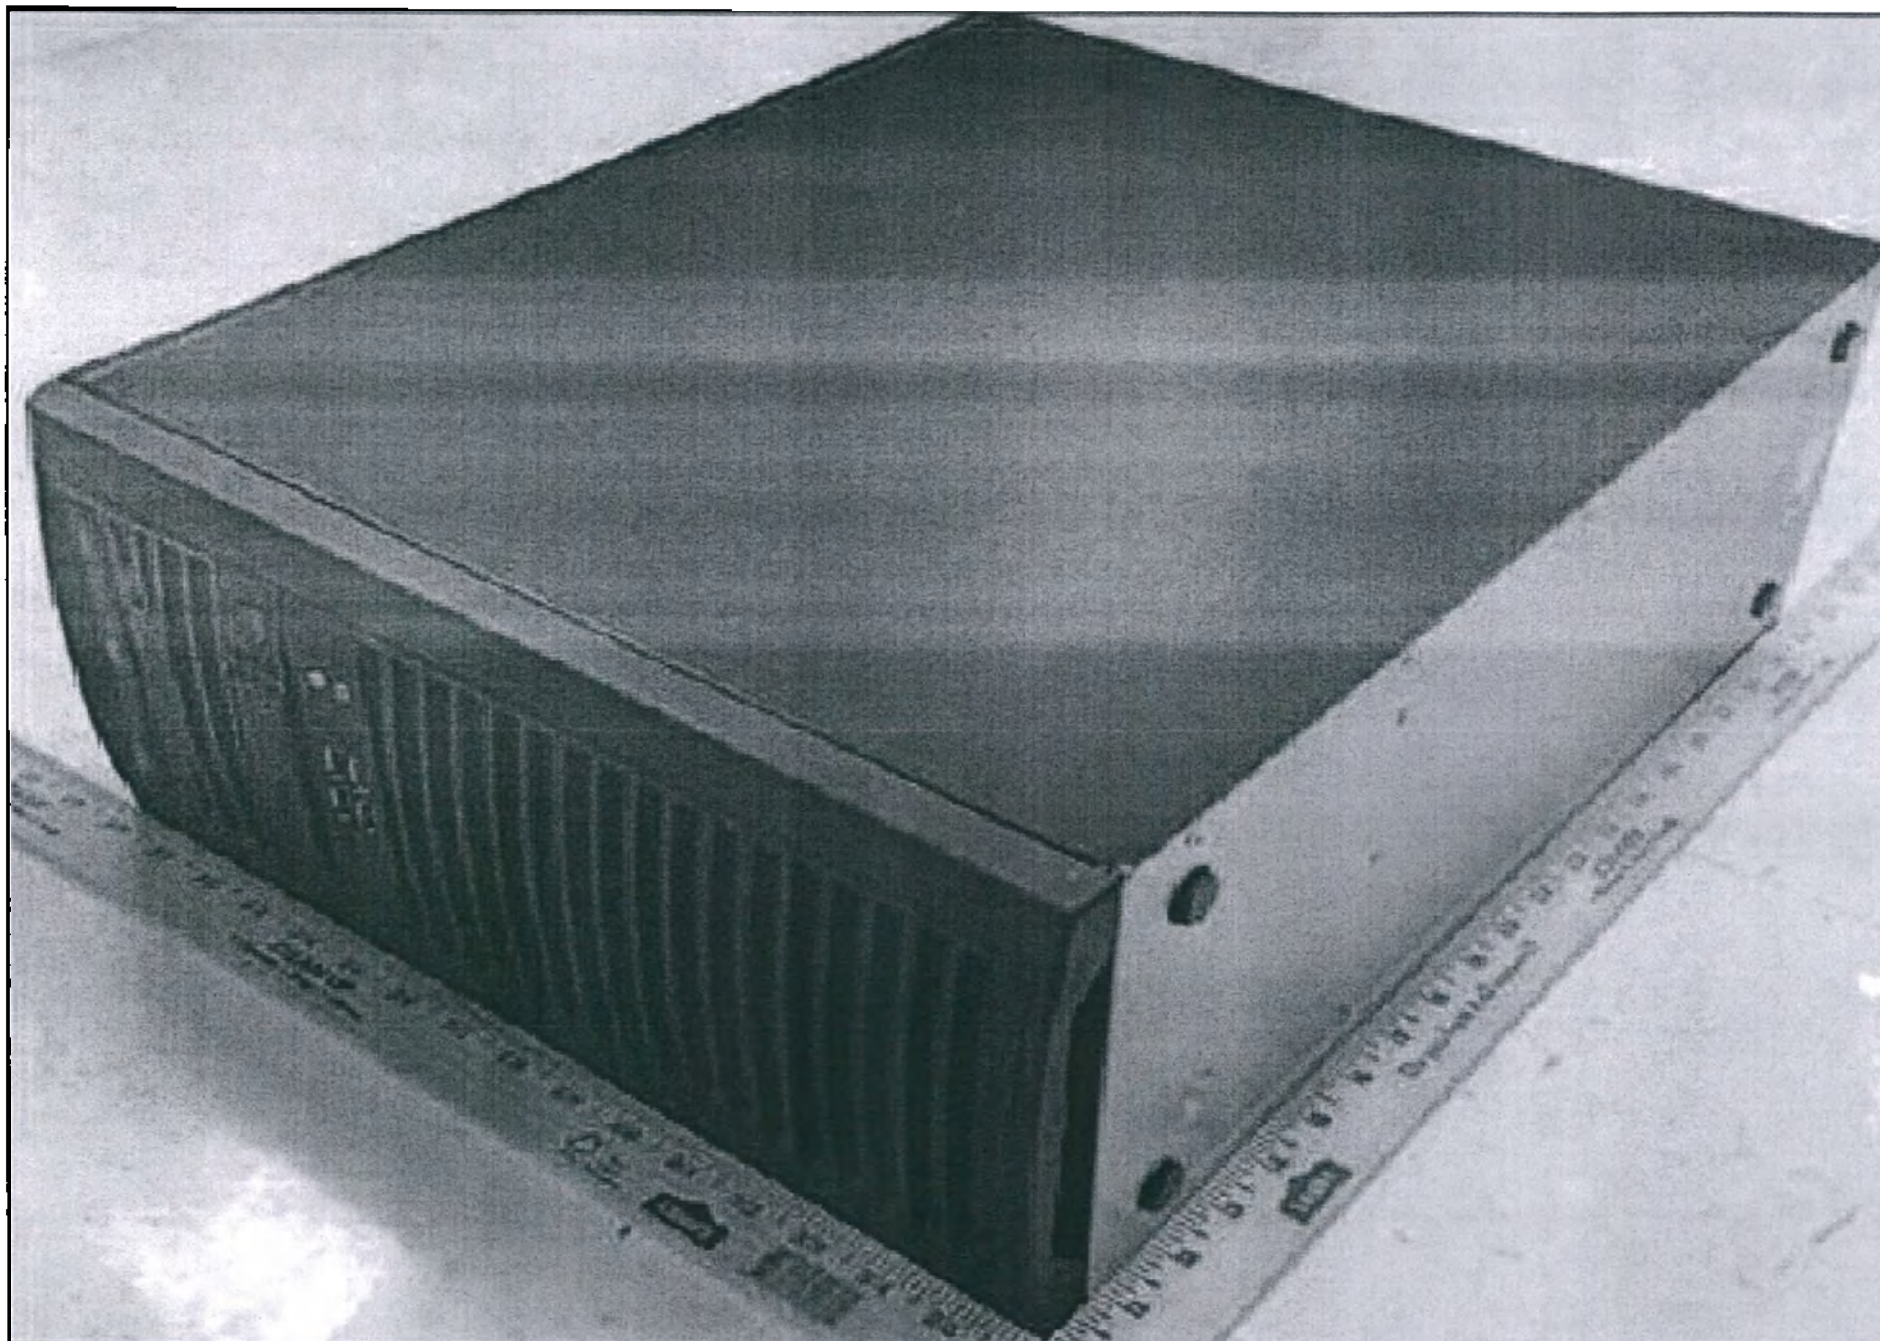


10.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

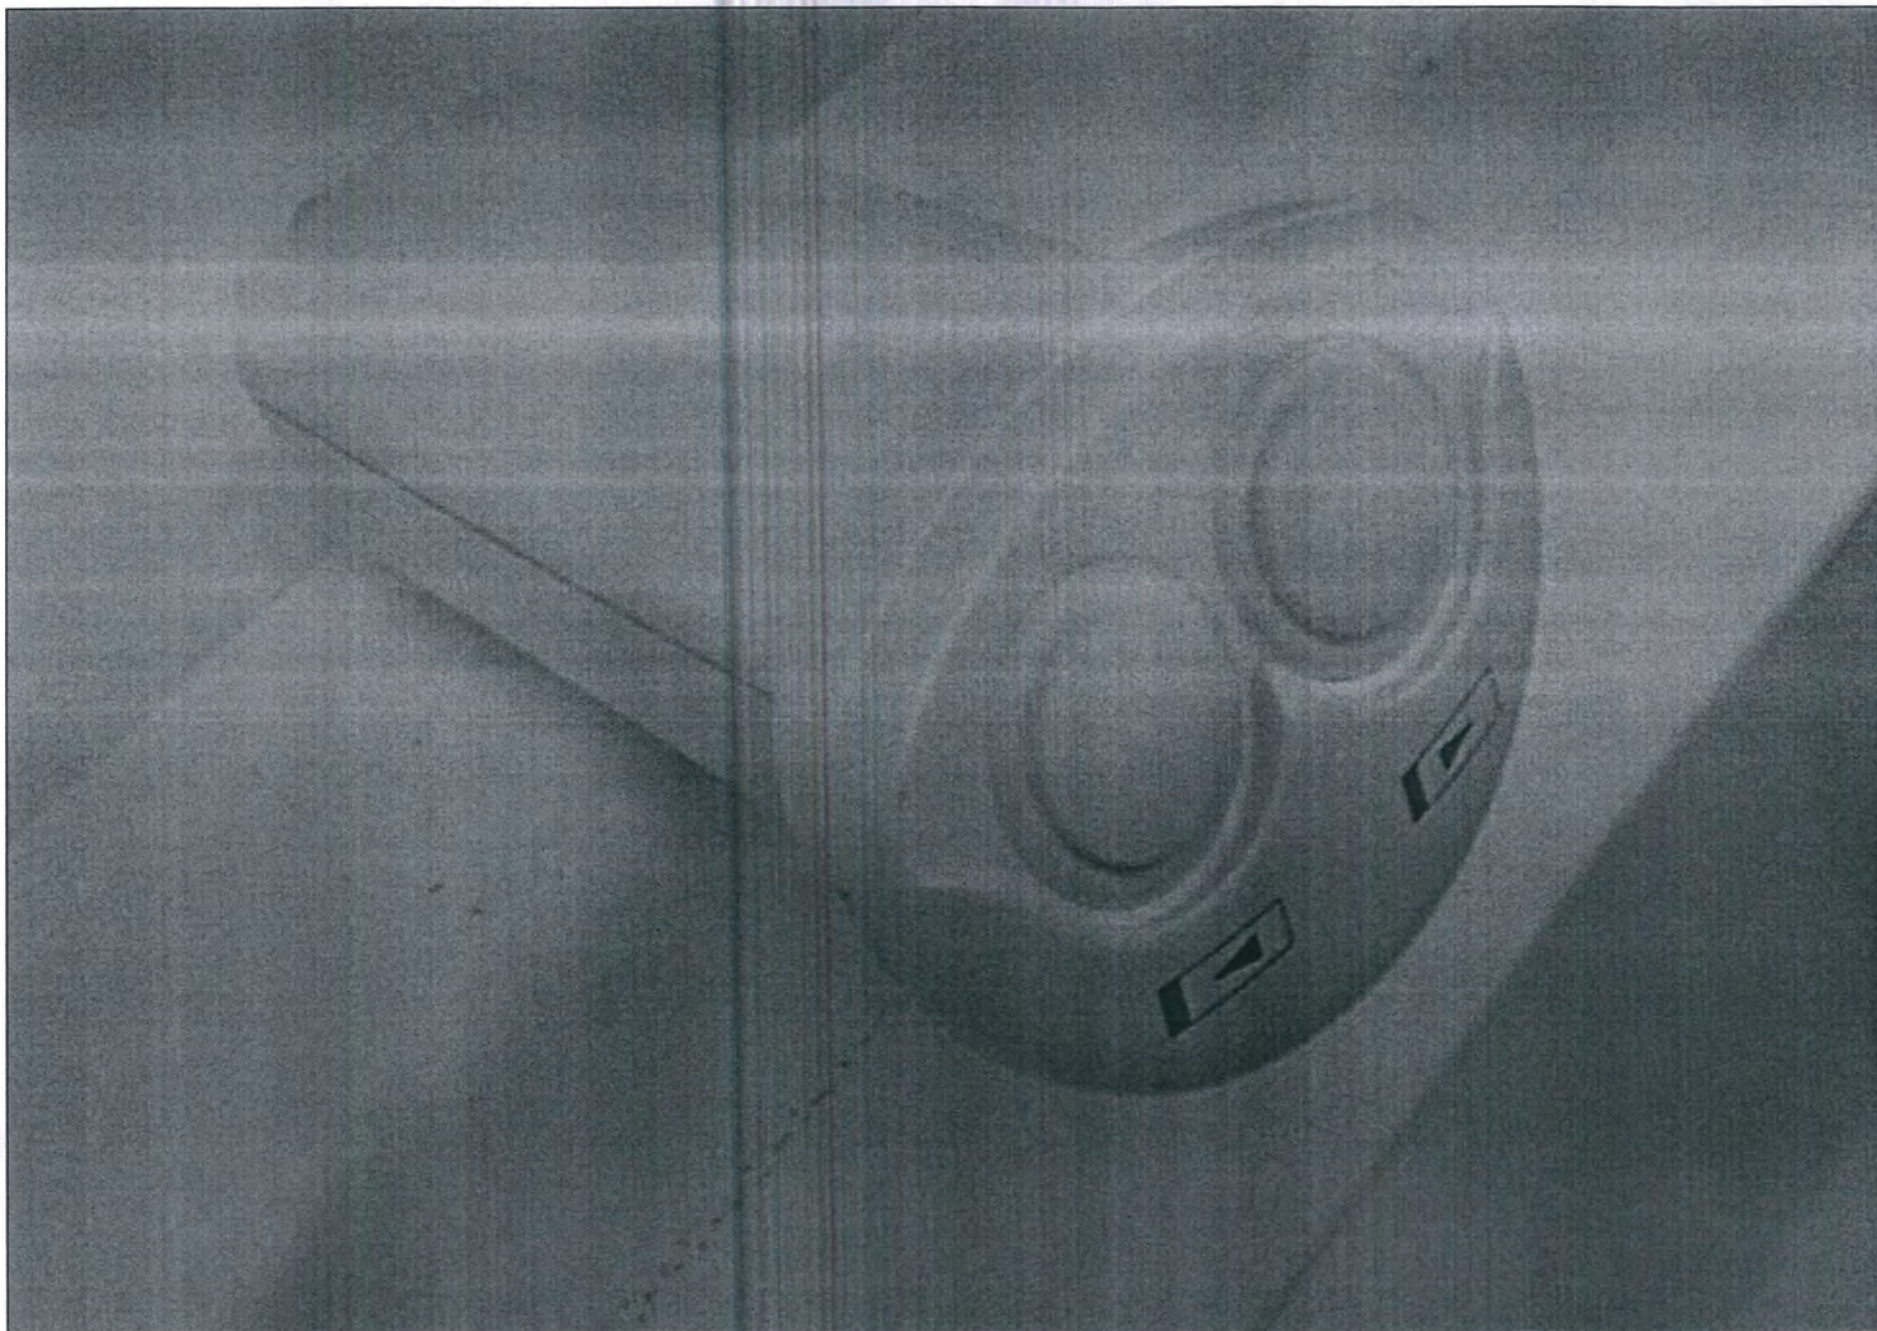


11. Ручной переключатель сдвига.

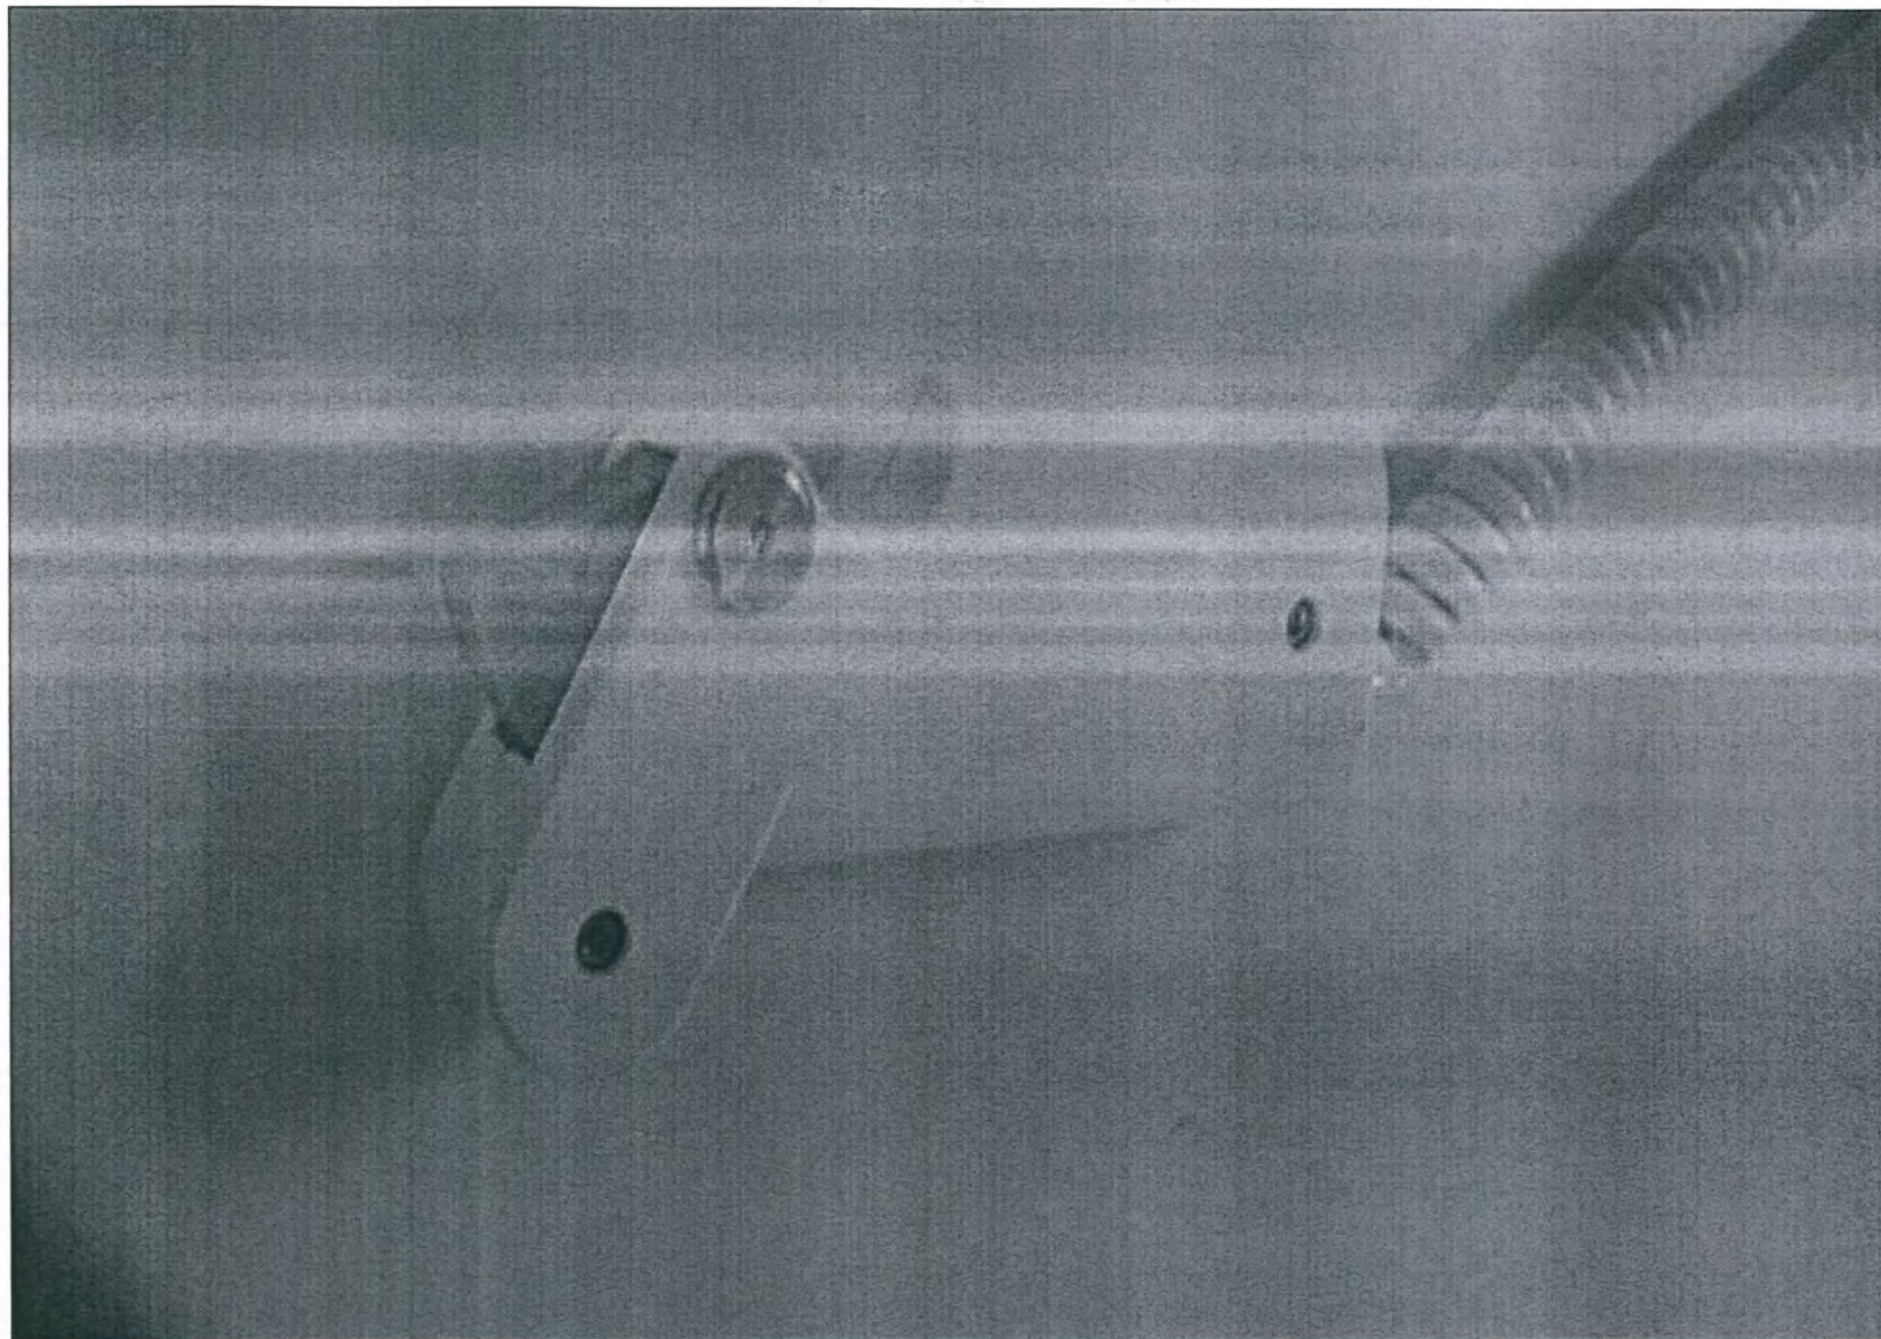


12. Регулятор скорости.

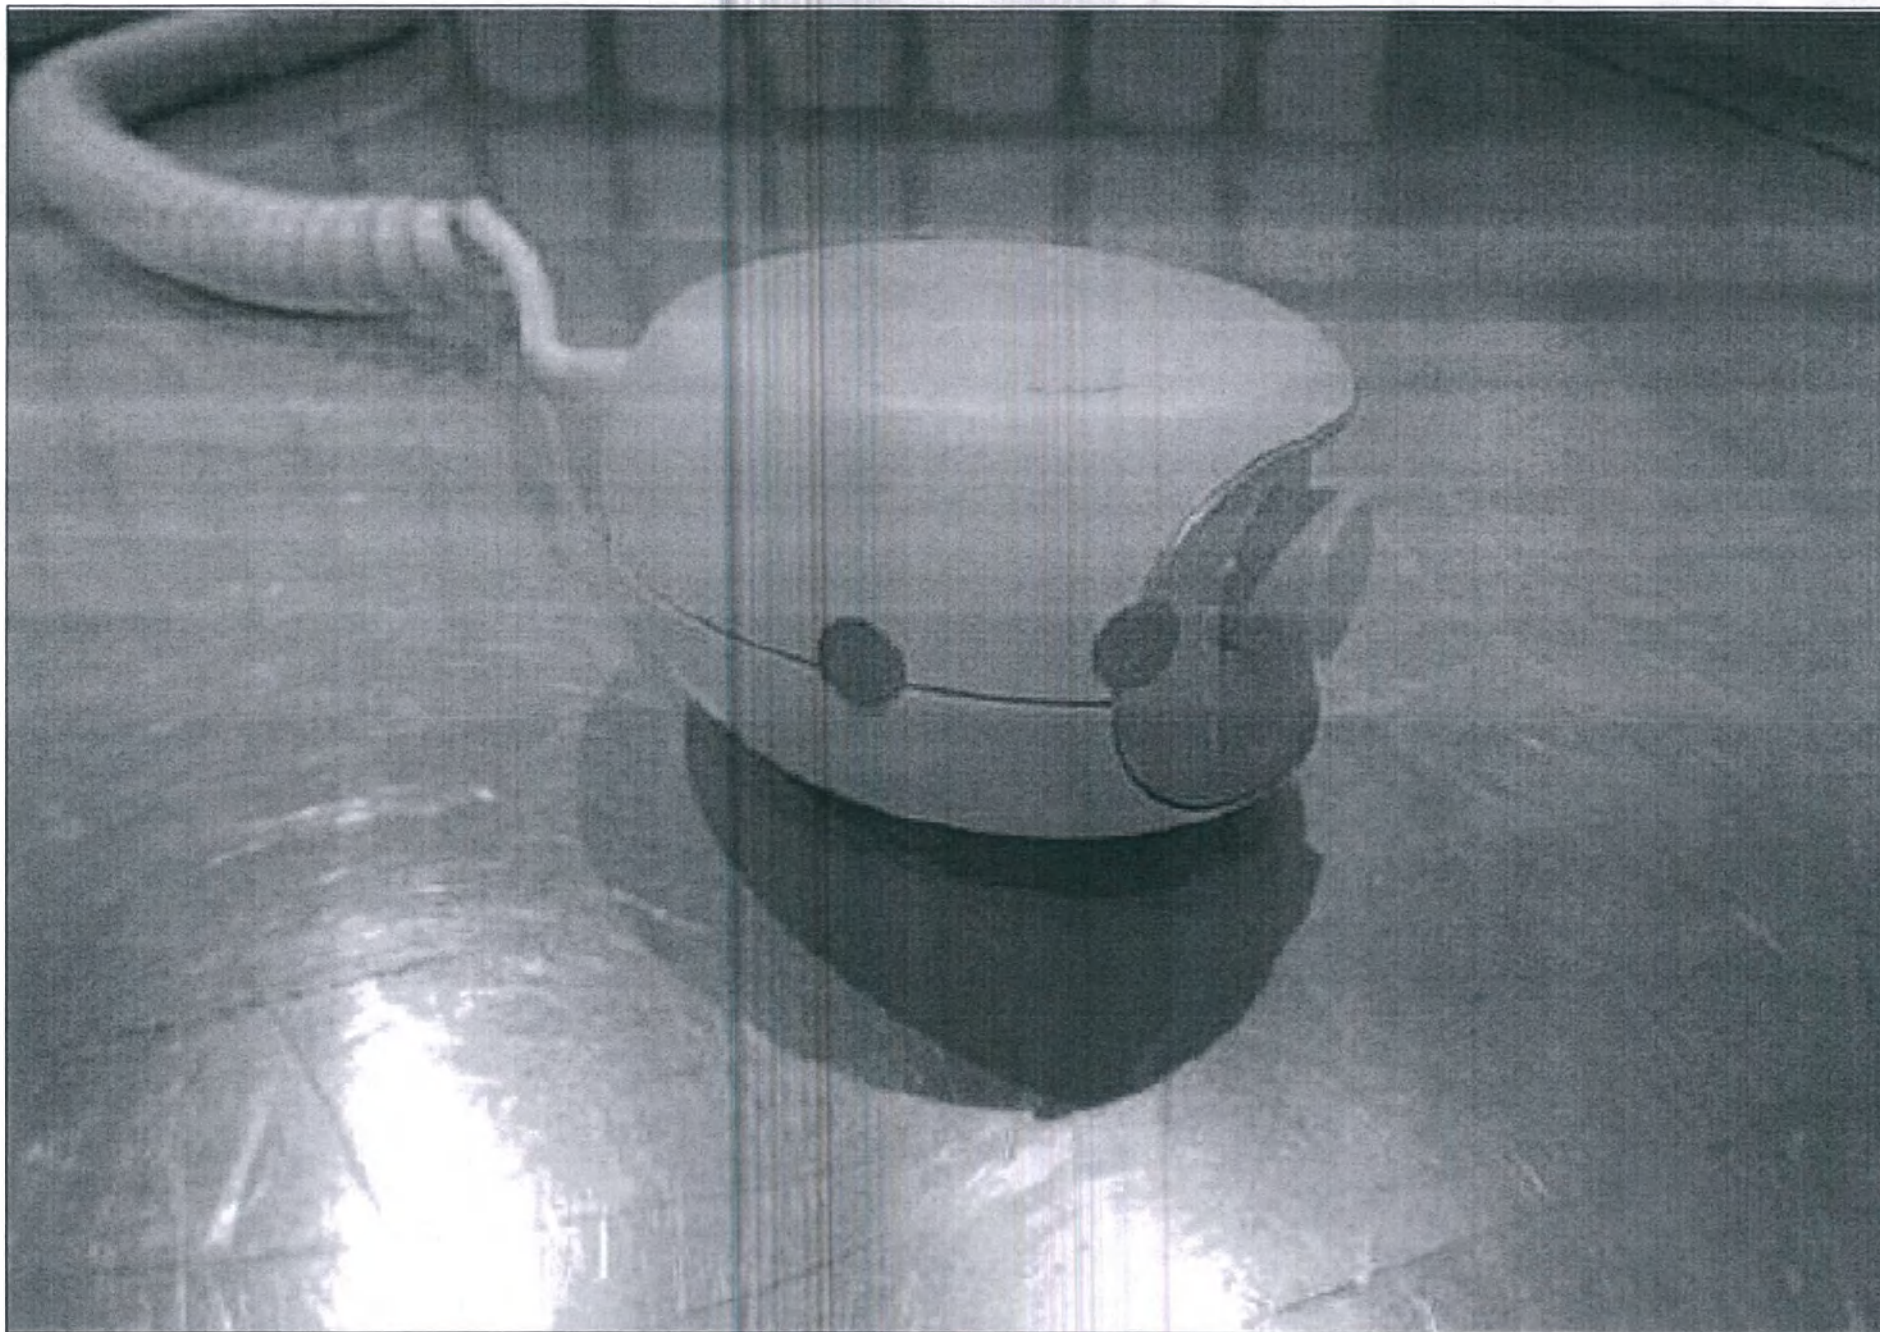


13. Ручной переключатель экспозиции.

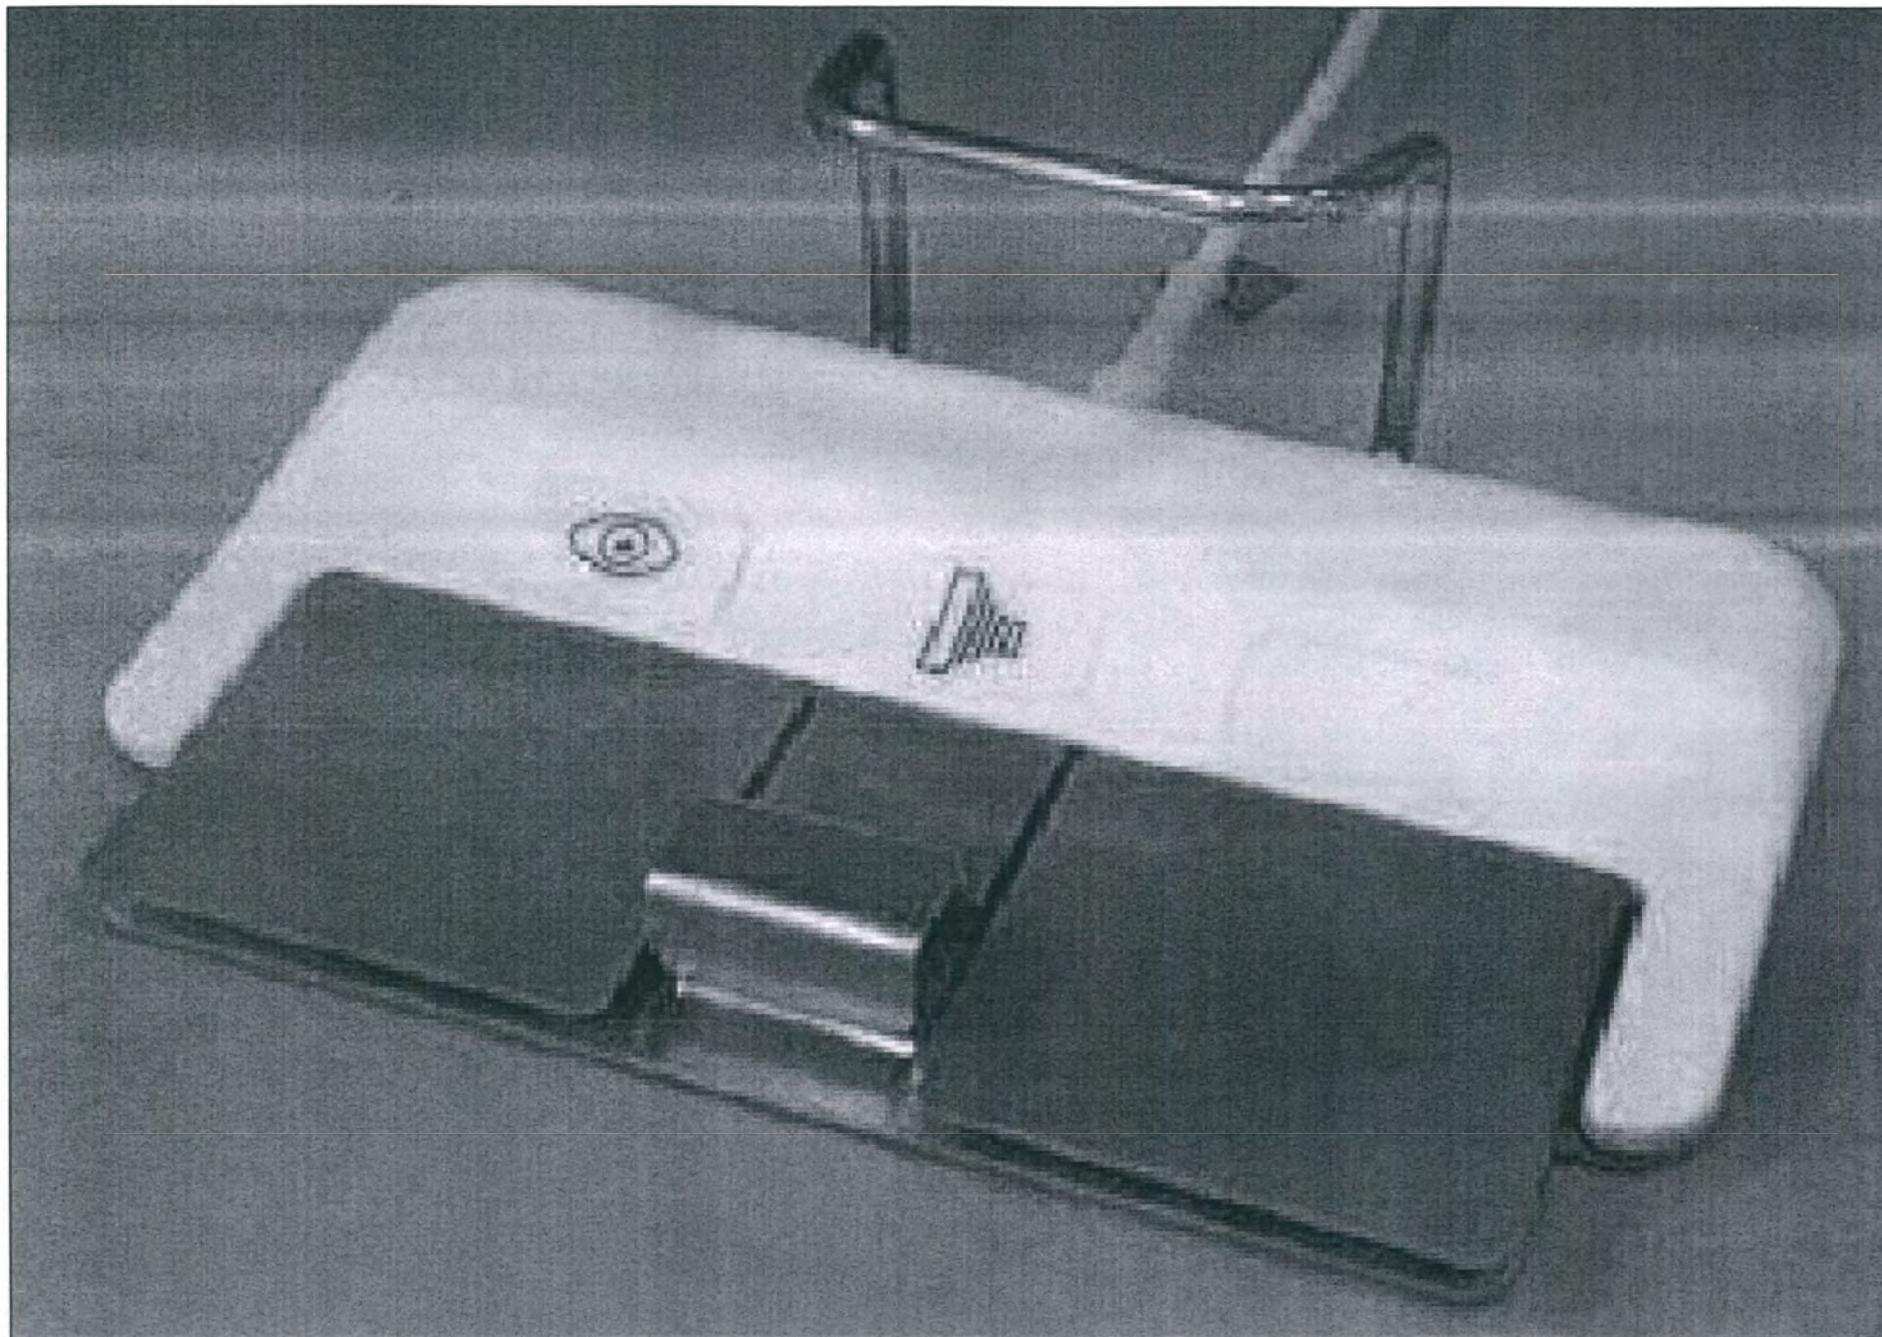


14. Ножной переключатель, не более 2 шт.

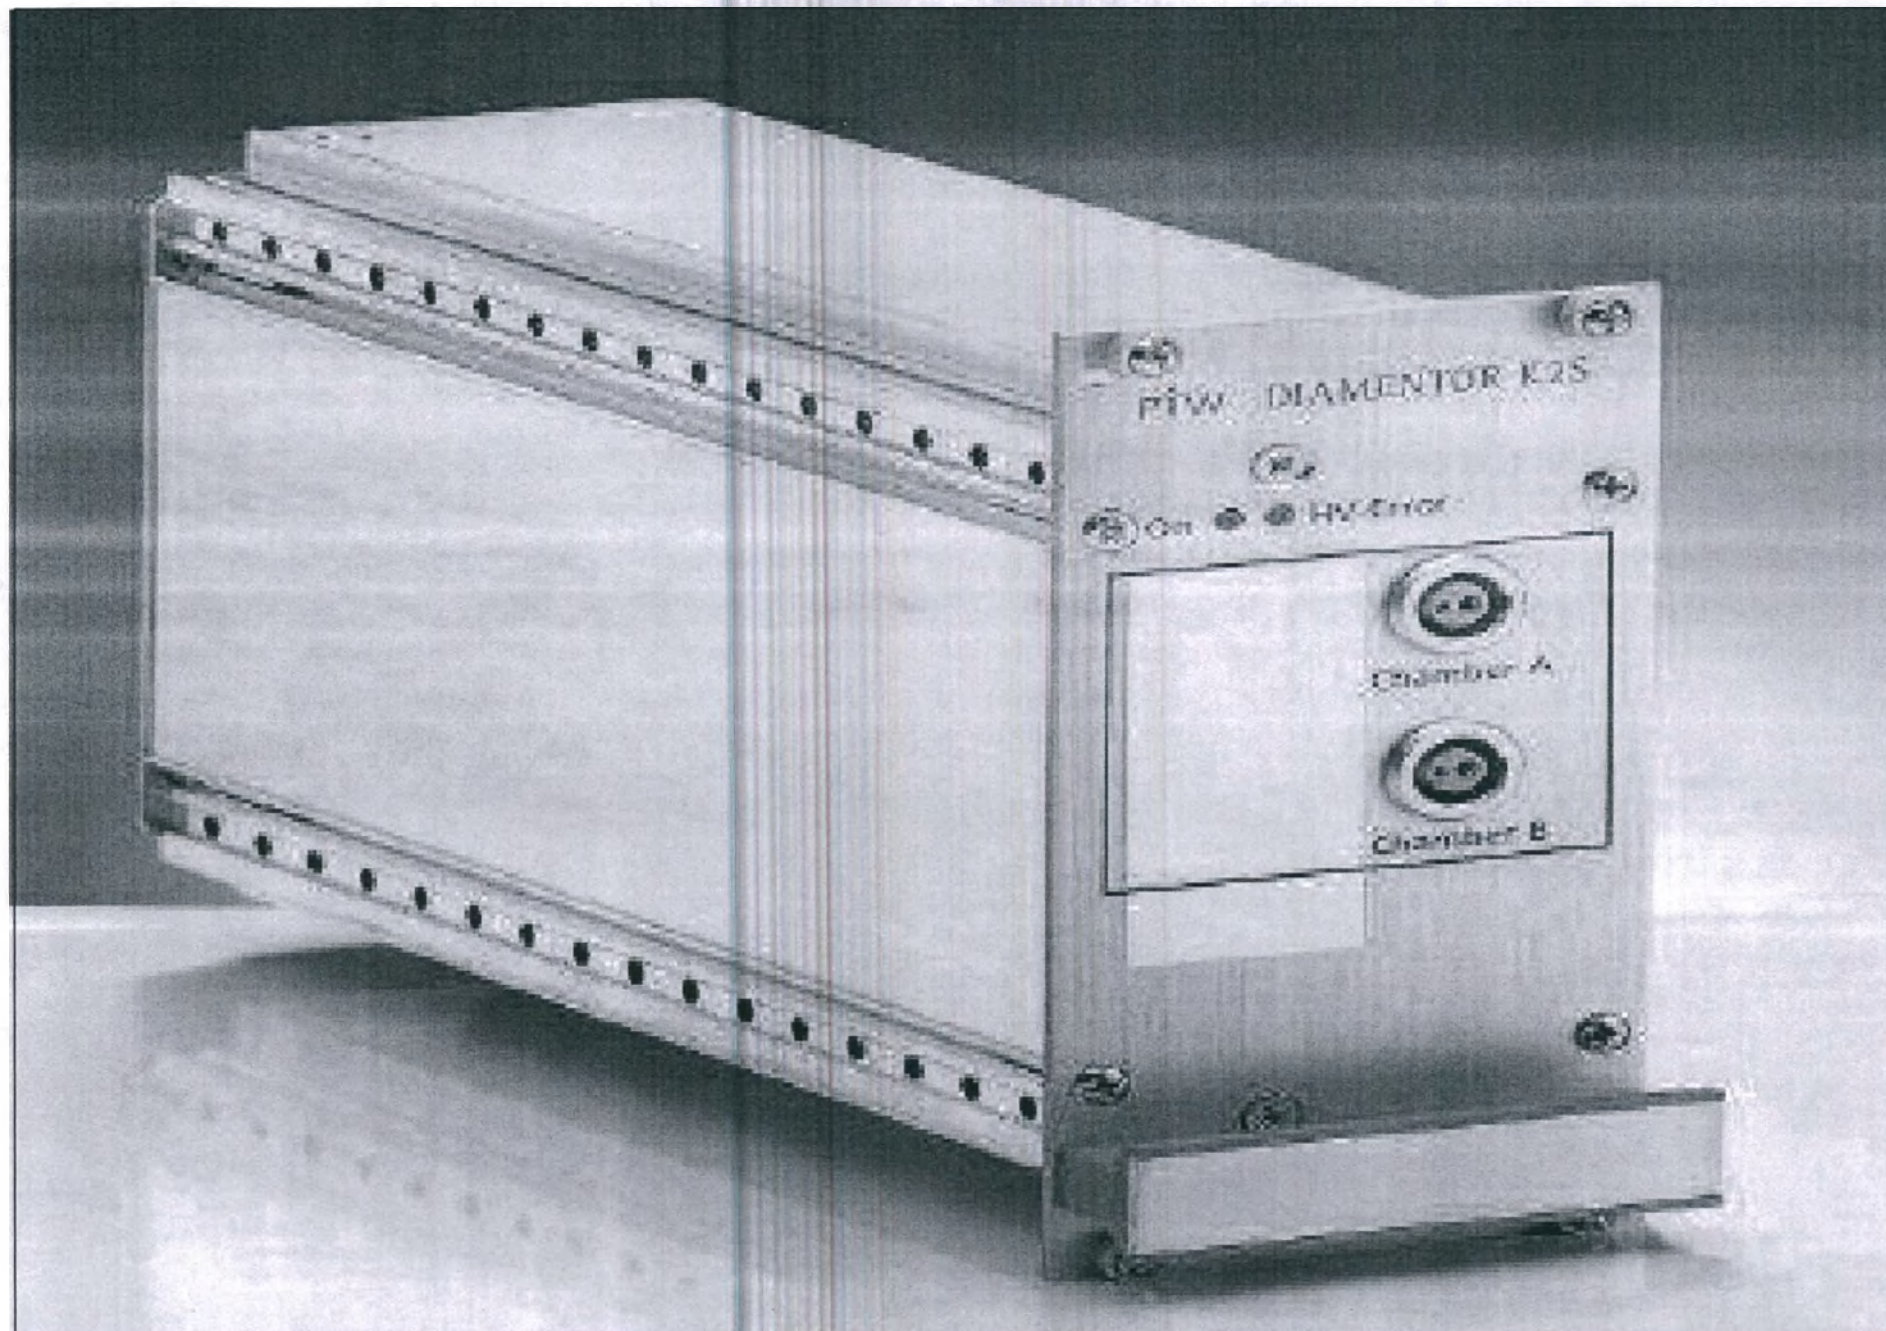


15.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

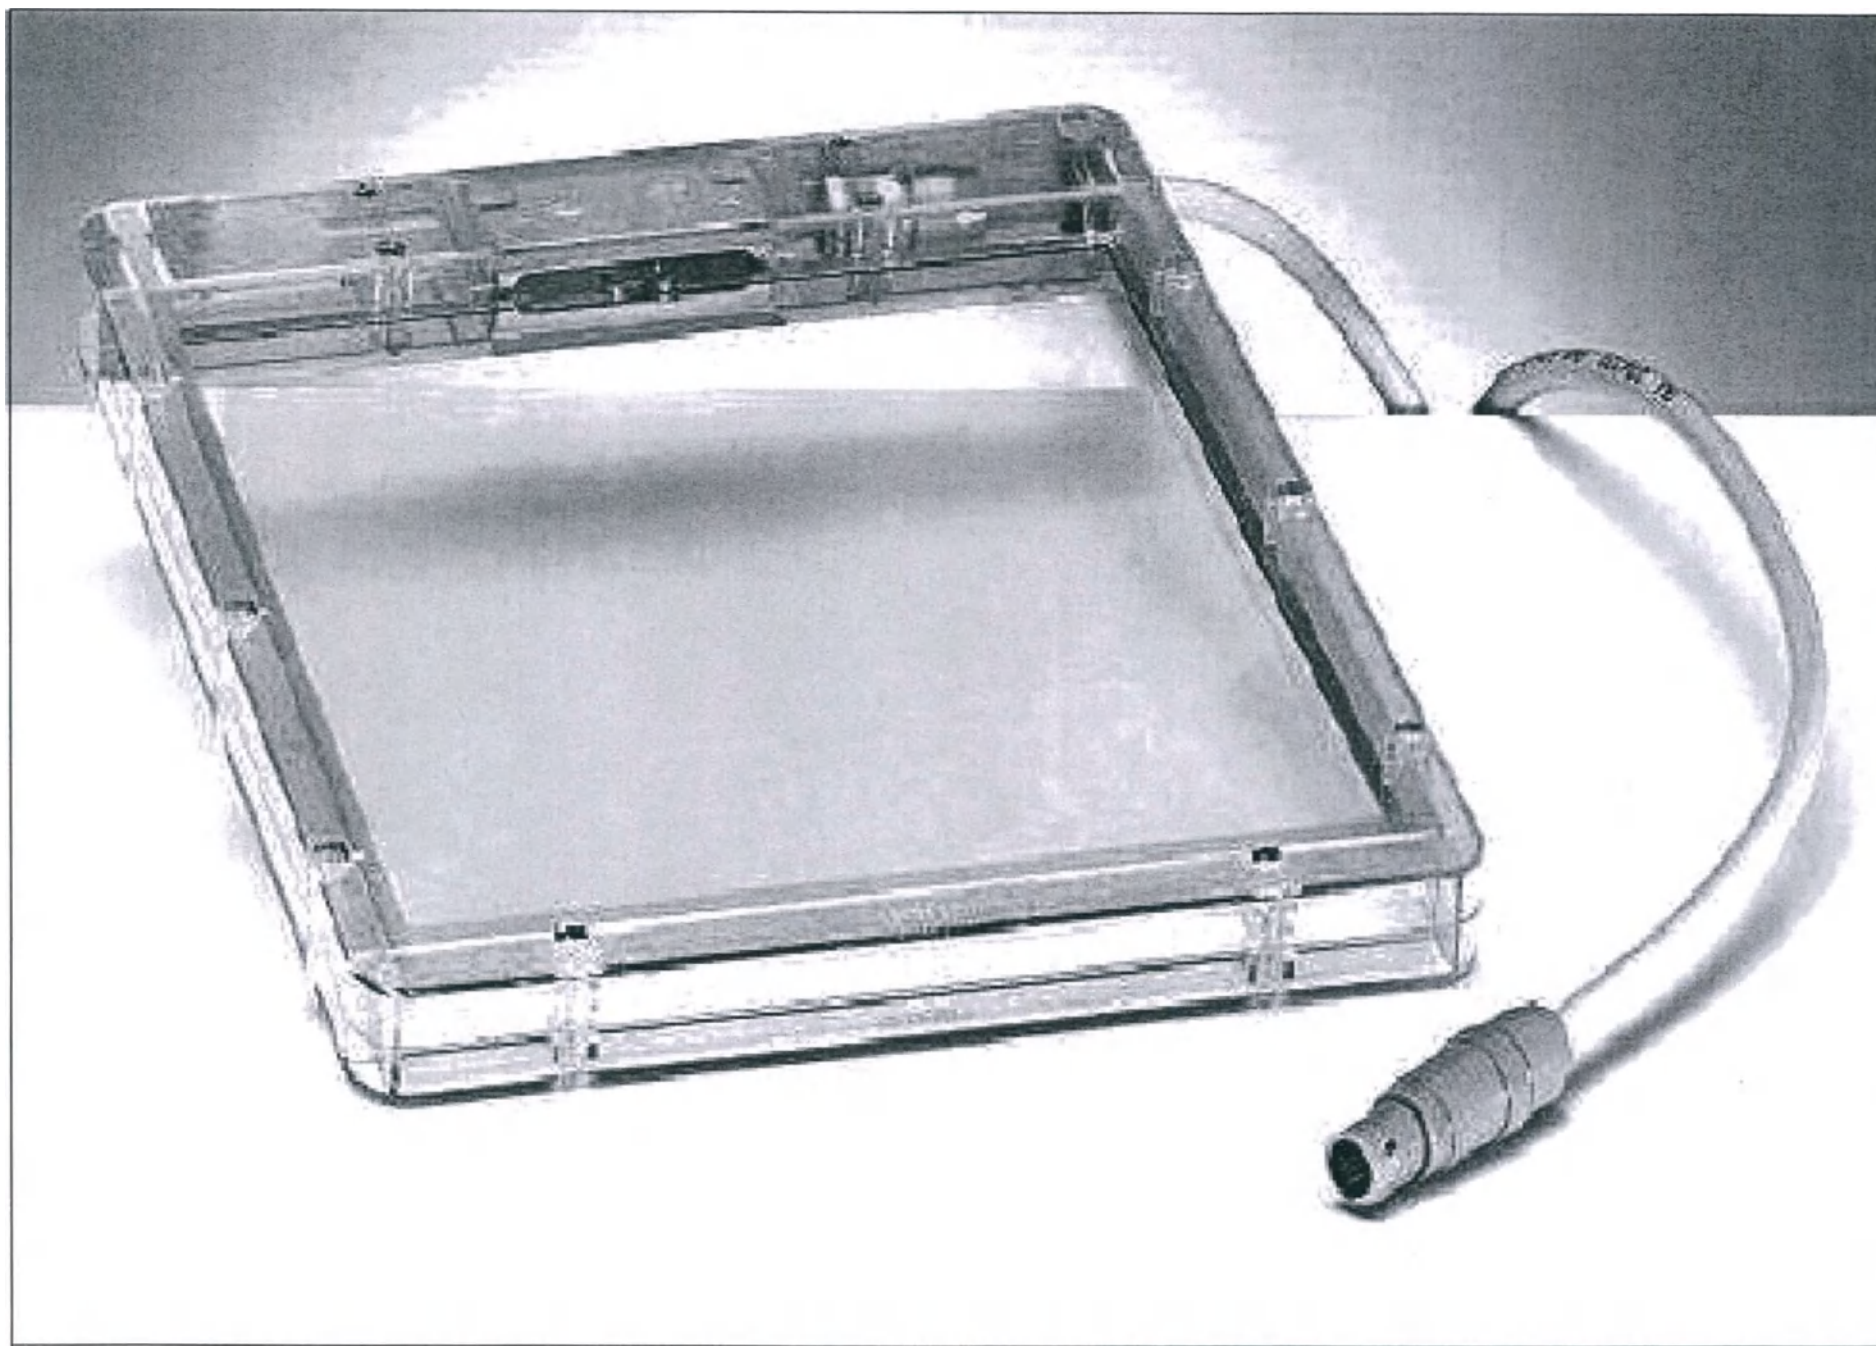


15.6. Дозиметр рентгеновского излучения *DIAMENTOR K1S T11028* или *DIAMENTOR K2S T11029* или *ДРК-1* или *ДРК-1М*.

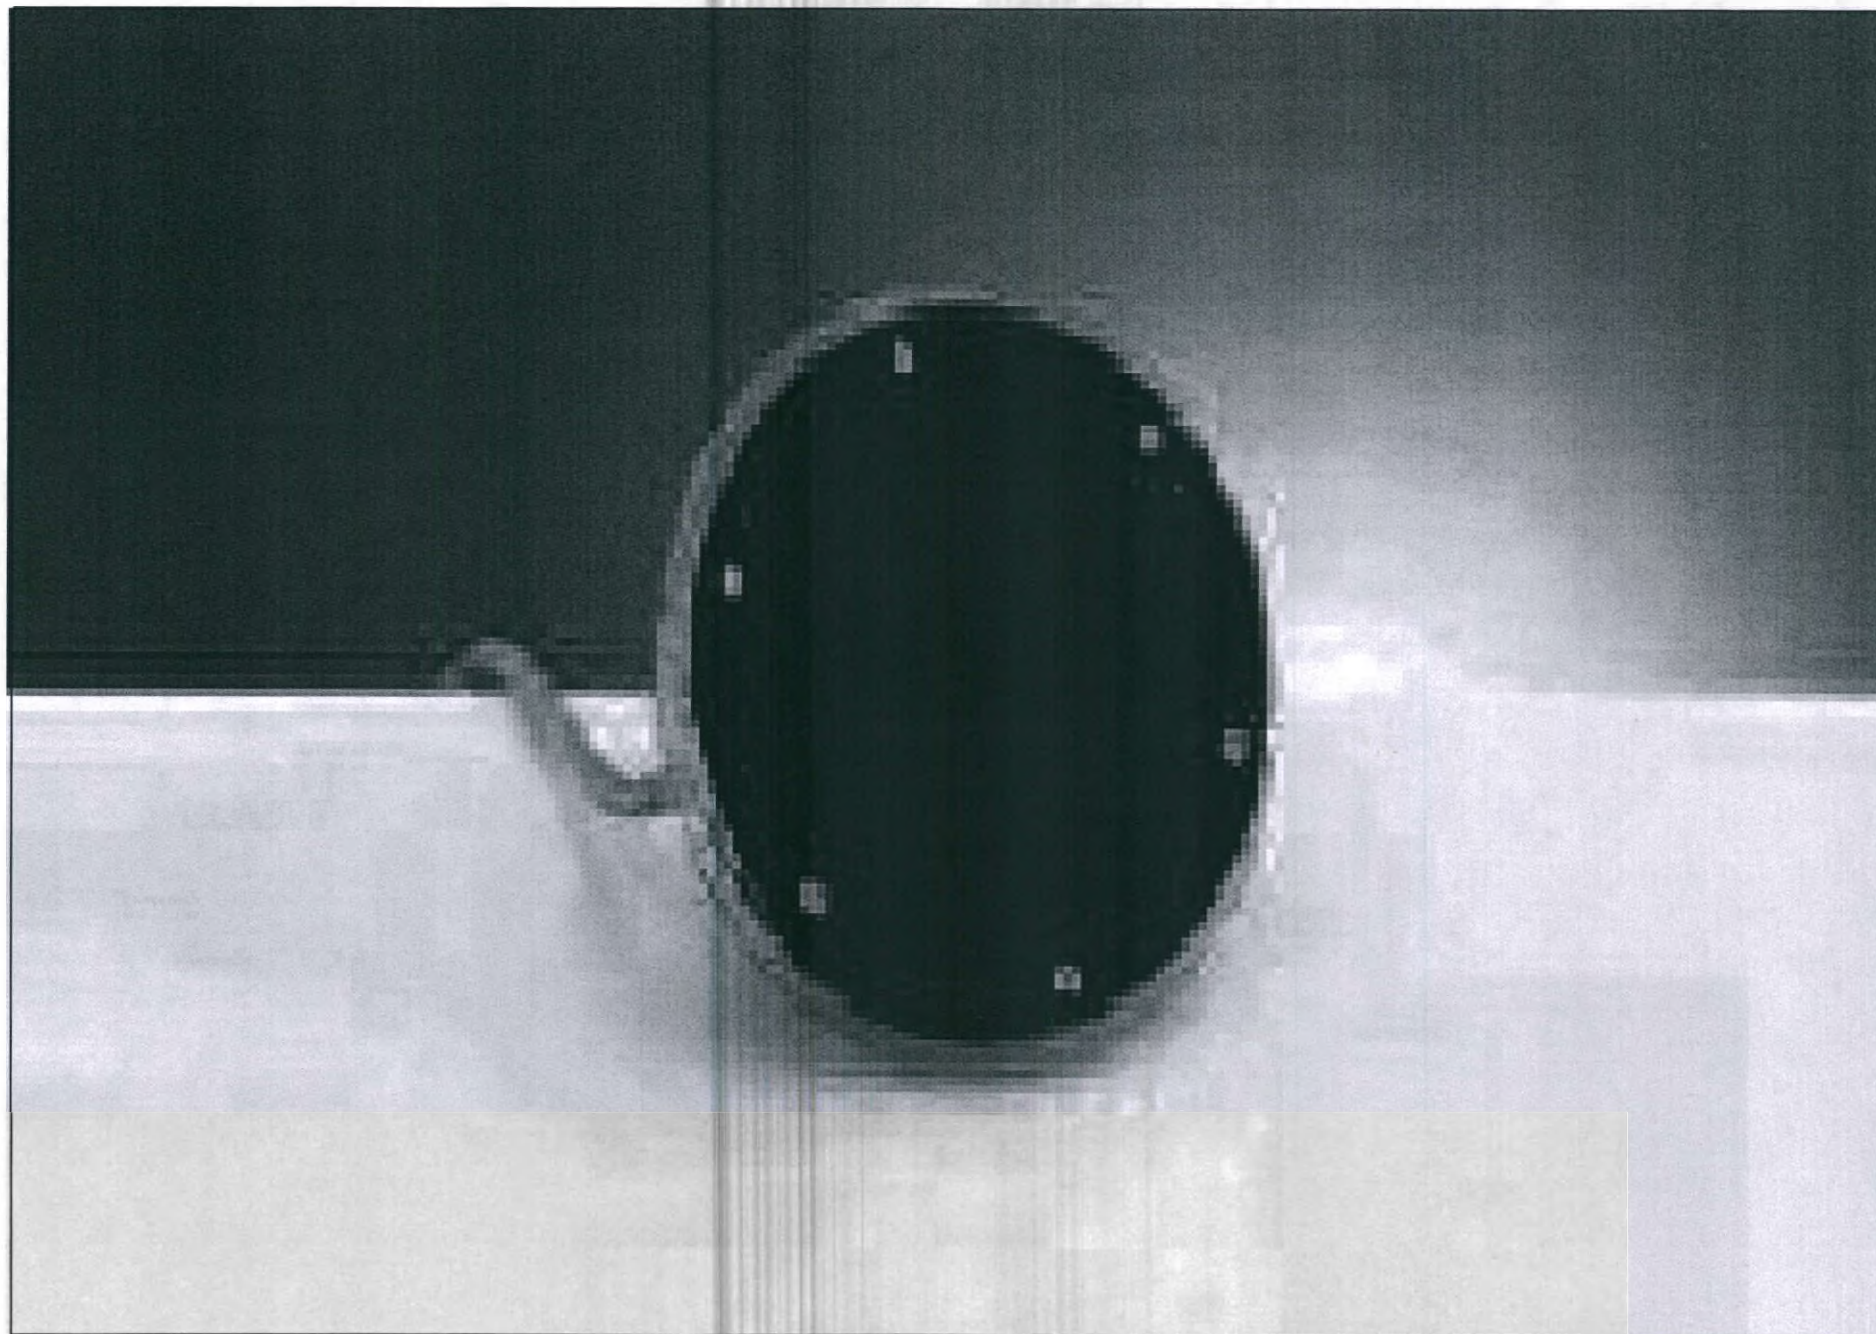


15.в. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

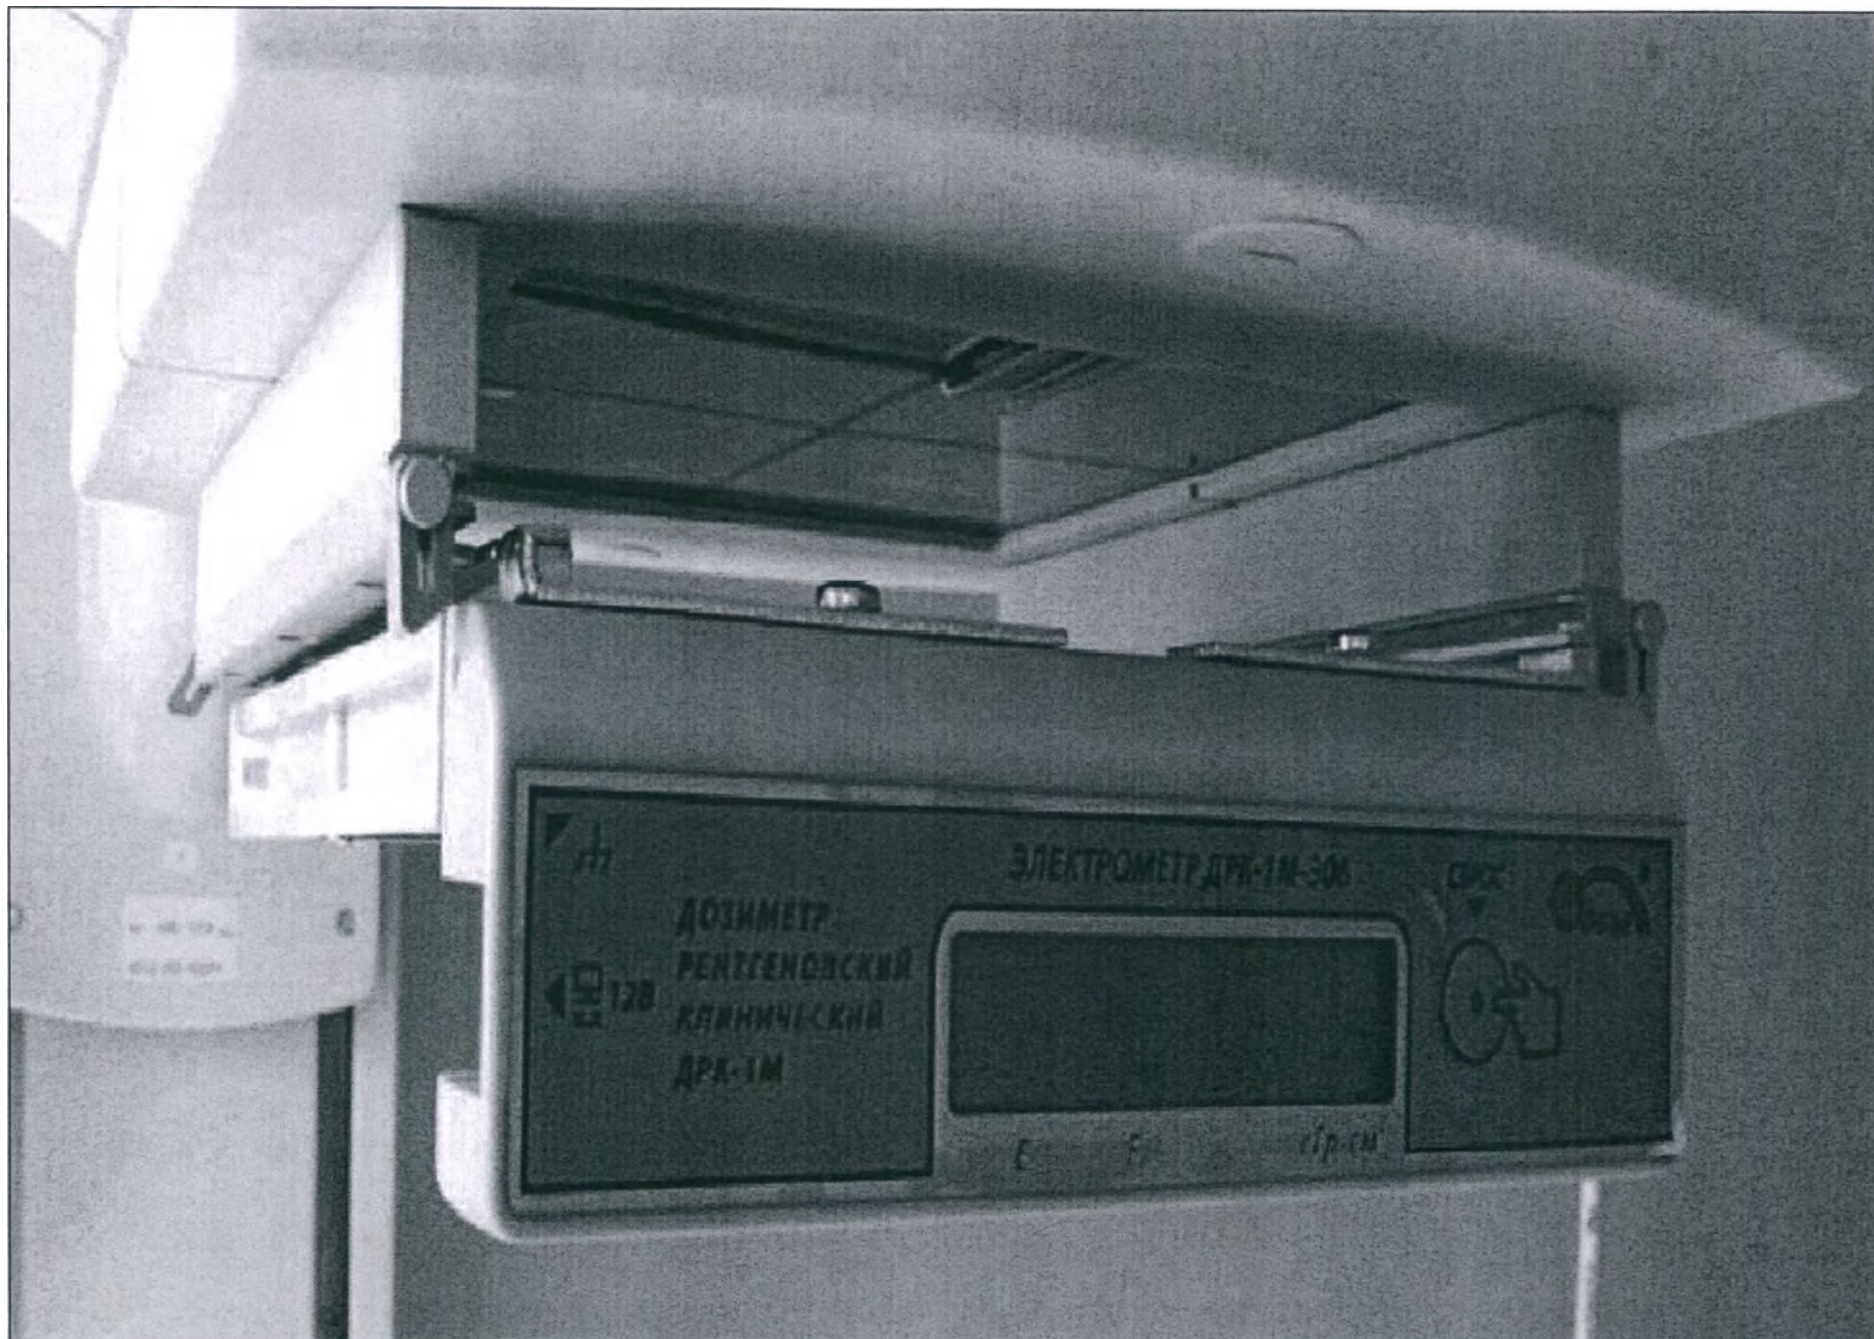


15.2. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

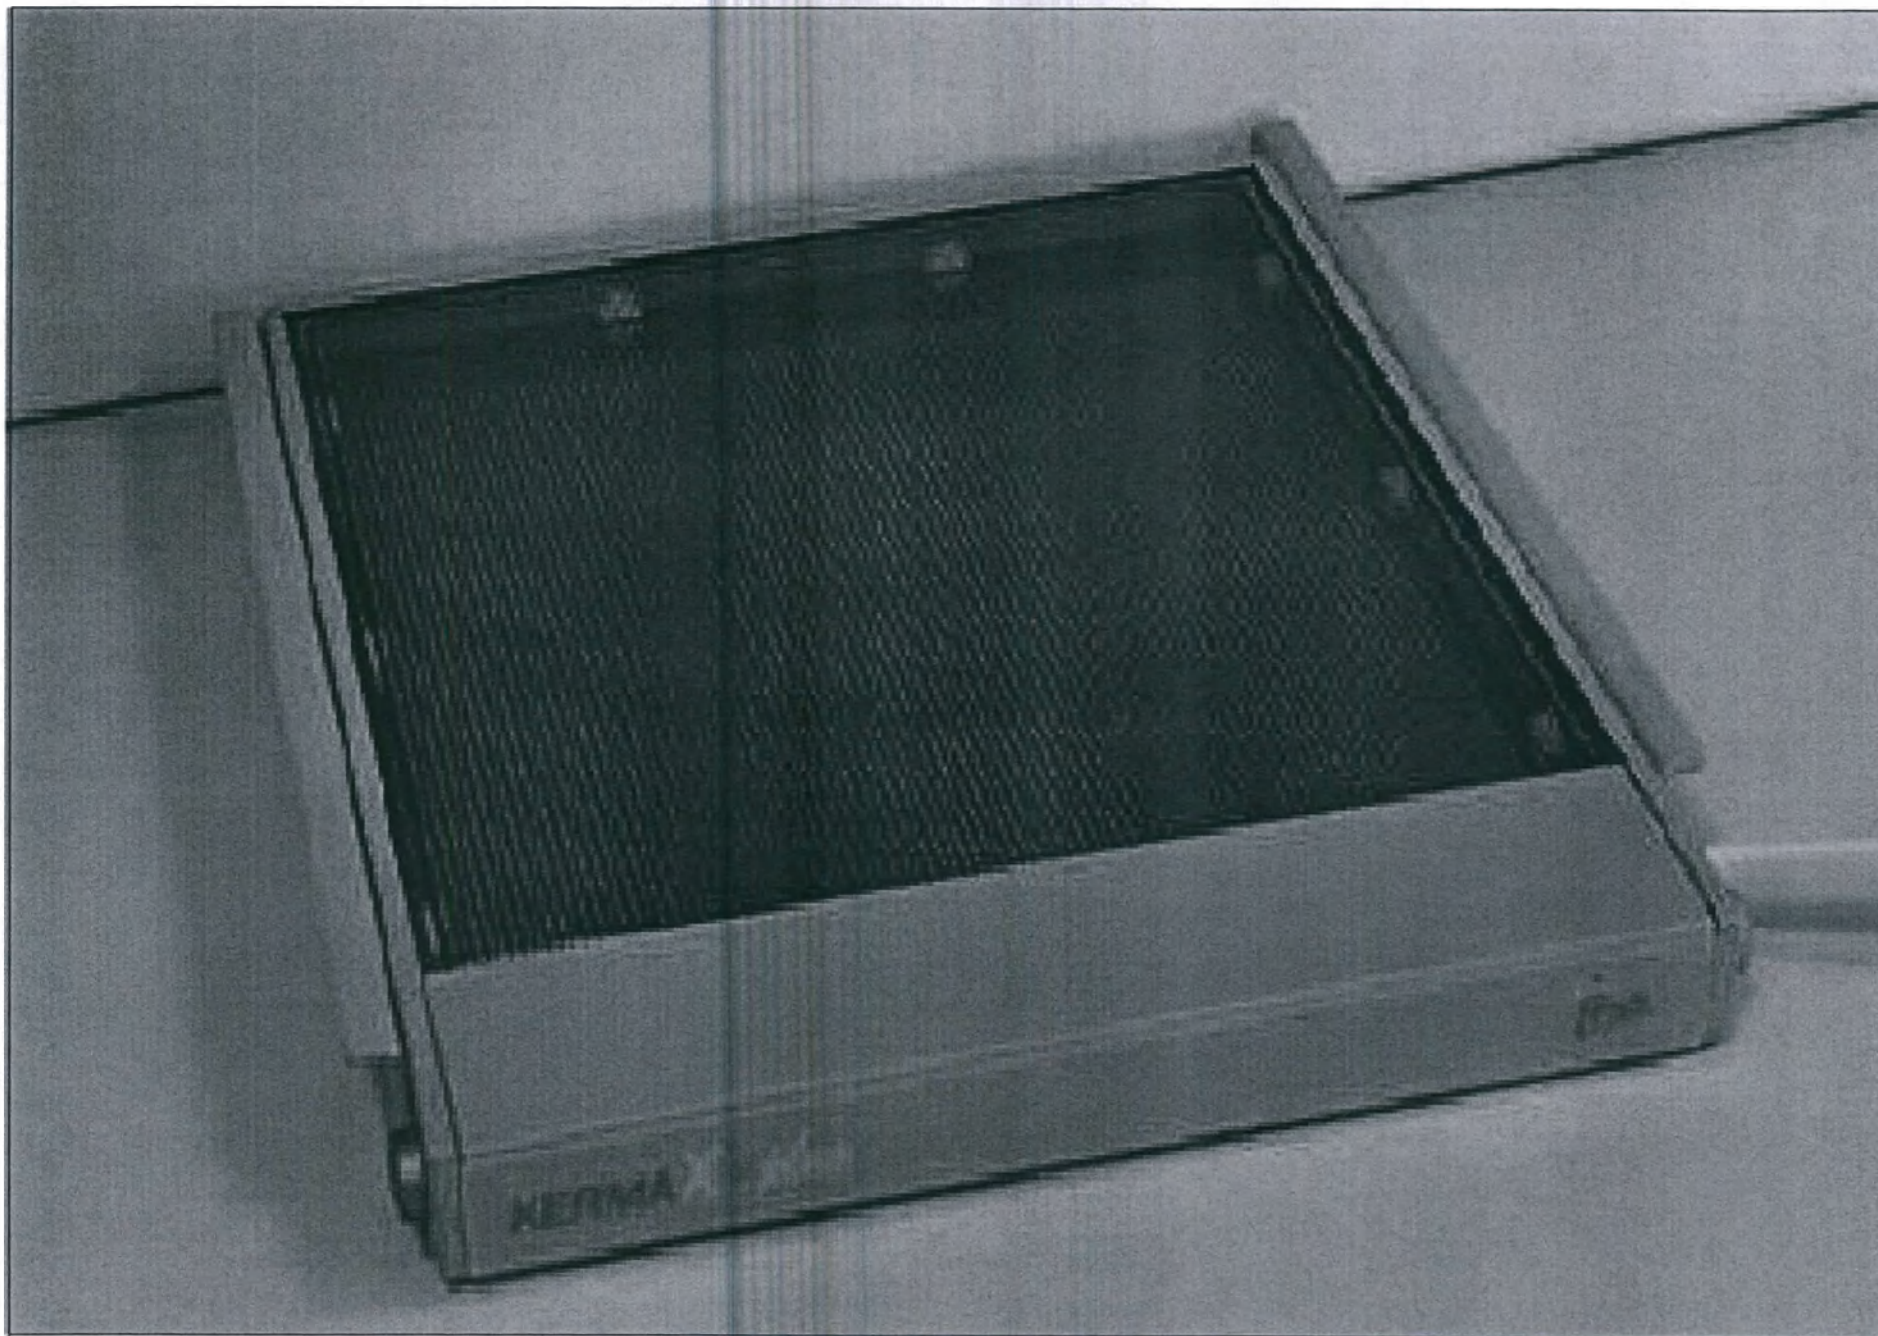

16. Измеритель производства дозы на площадь KermaX plus 120-132.

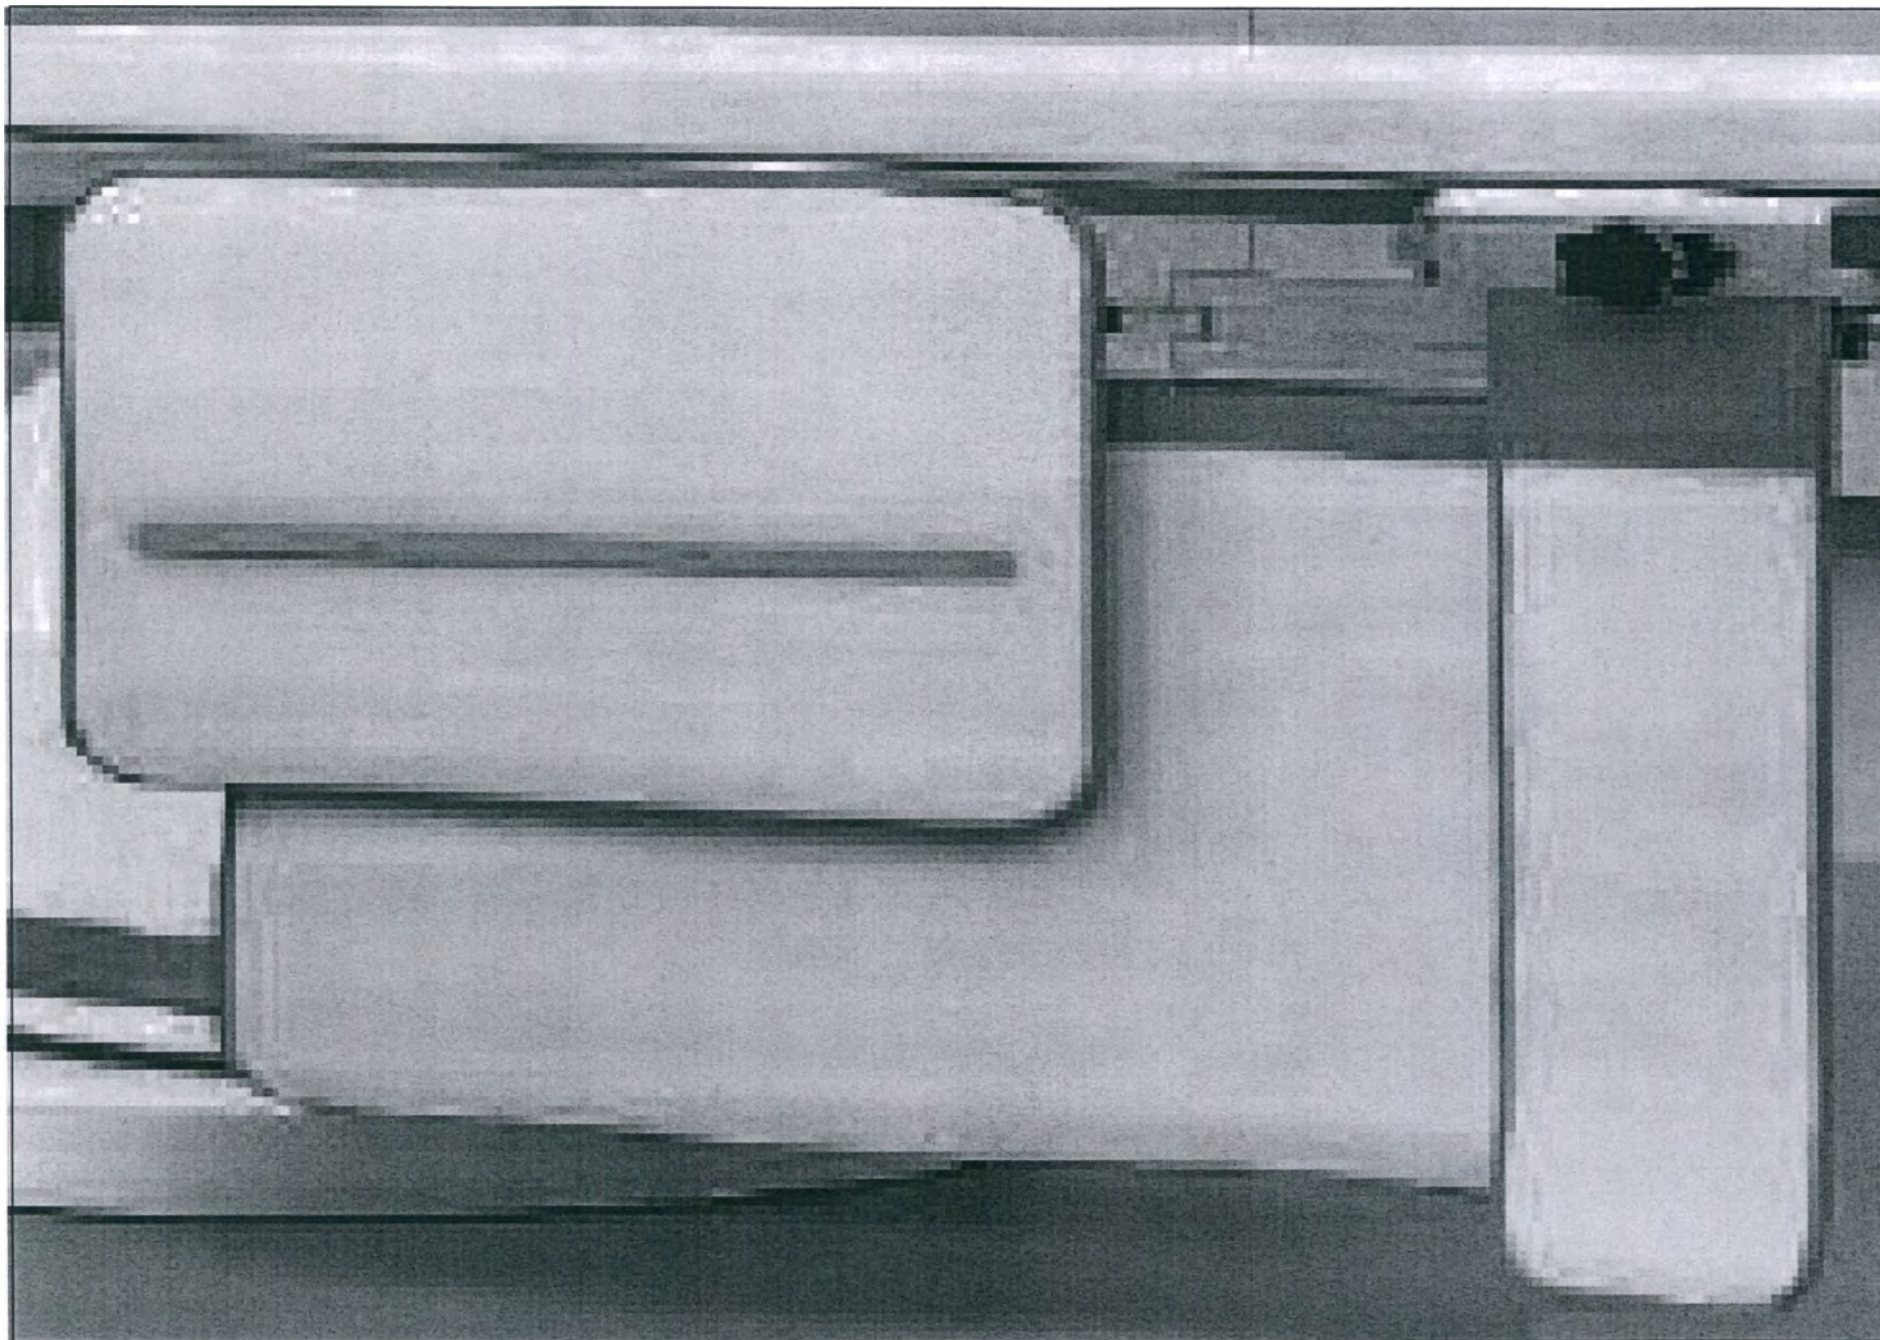


17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

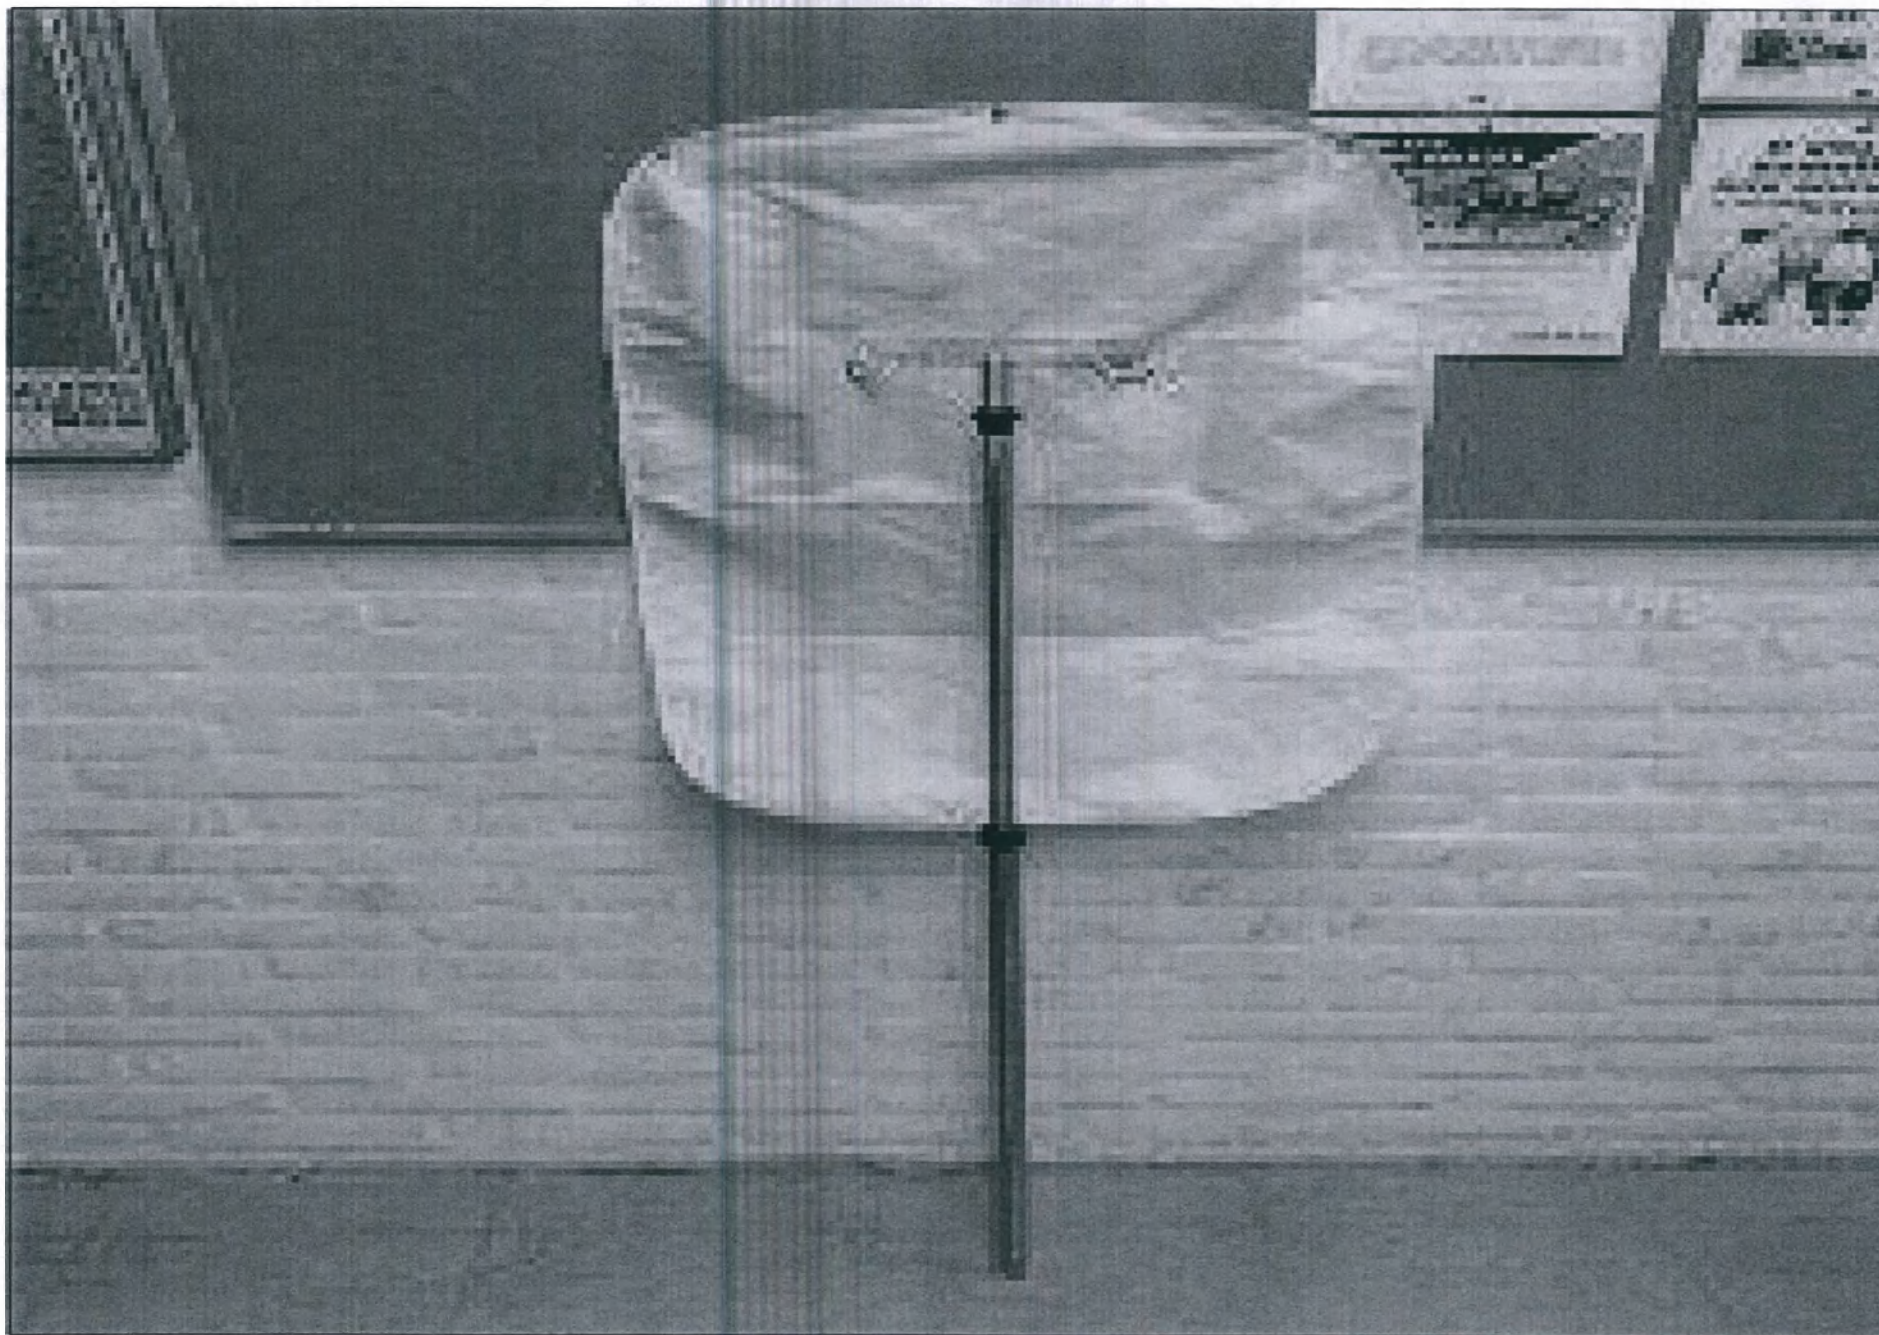


18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.



19. Лампа для осмотра

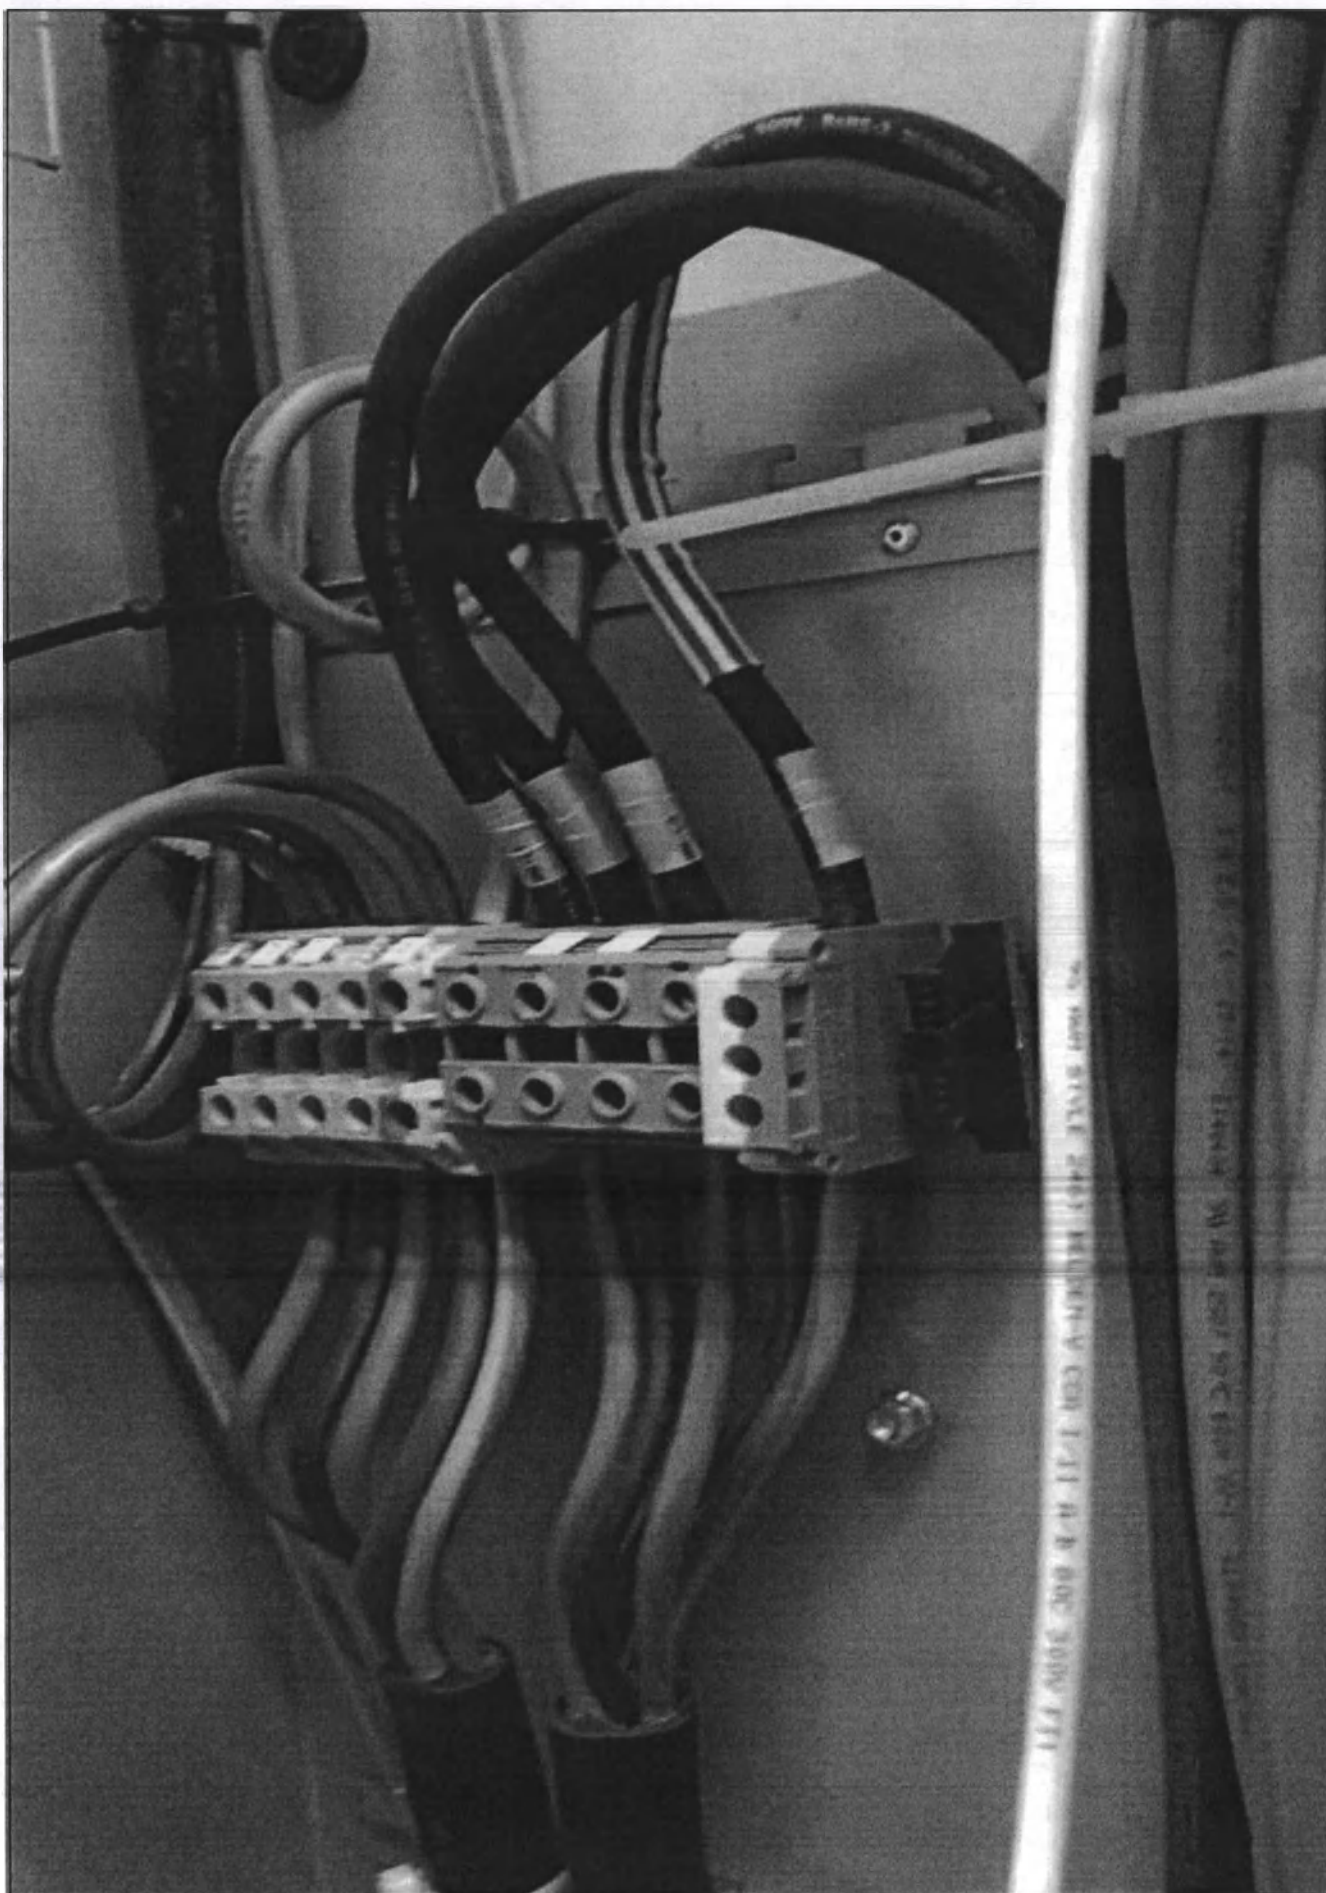

20. Кабели питания, 10 шт.

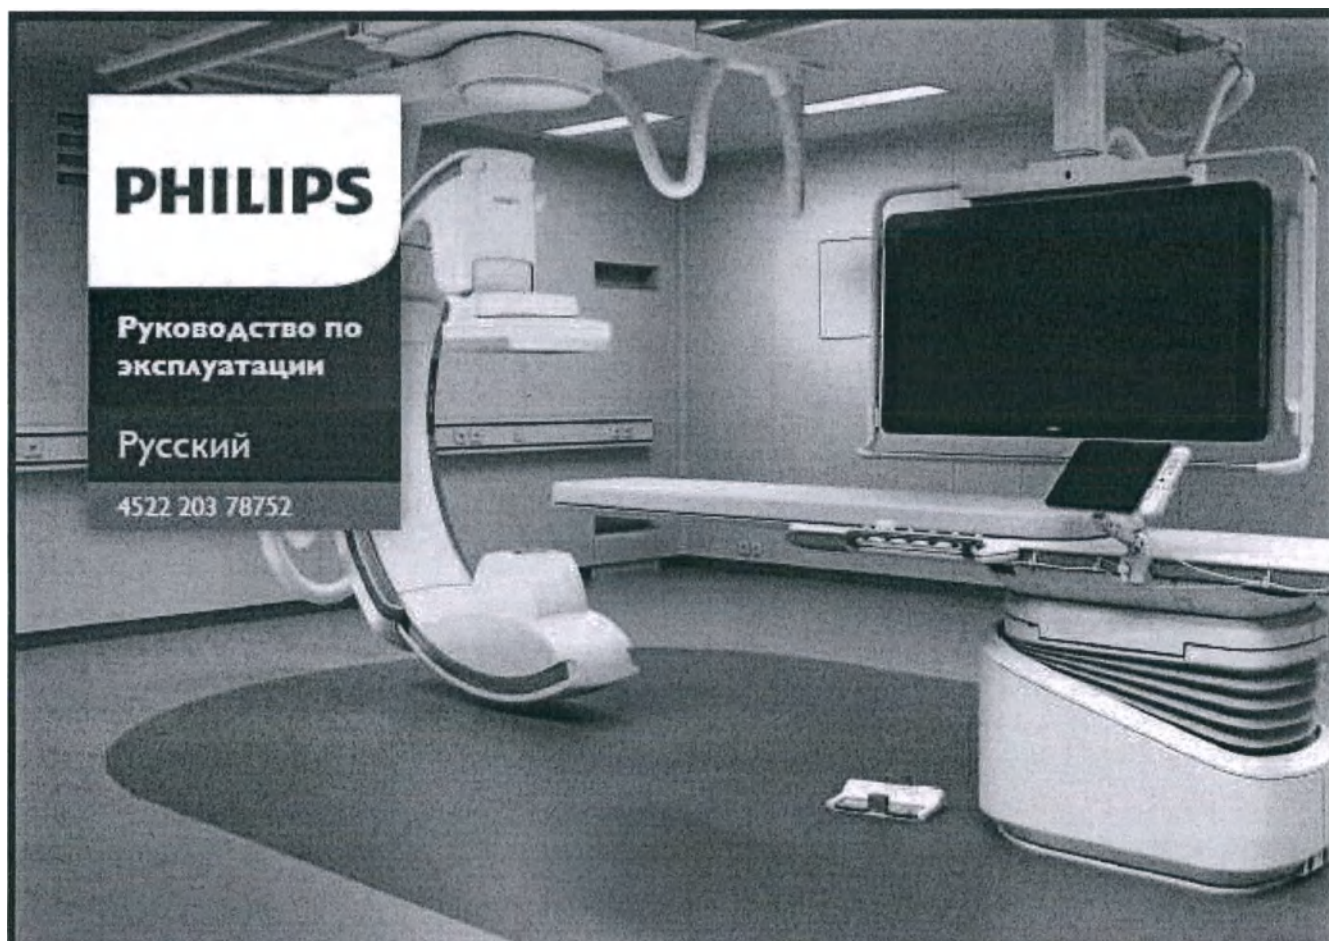

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации


Русский

4522 203 78752

Philips Azurion

Версия 2.1

21. а. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.

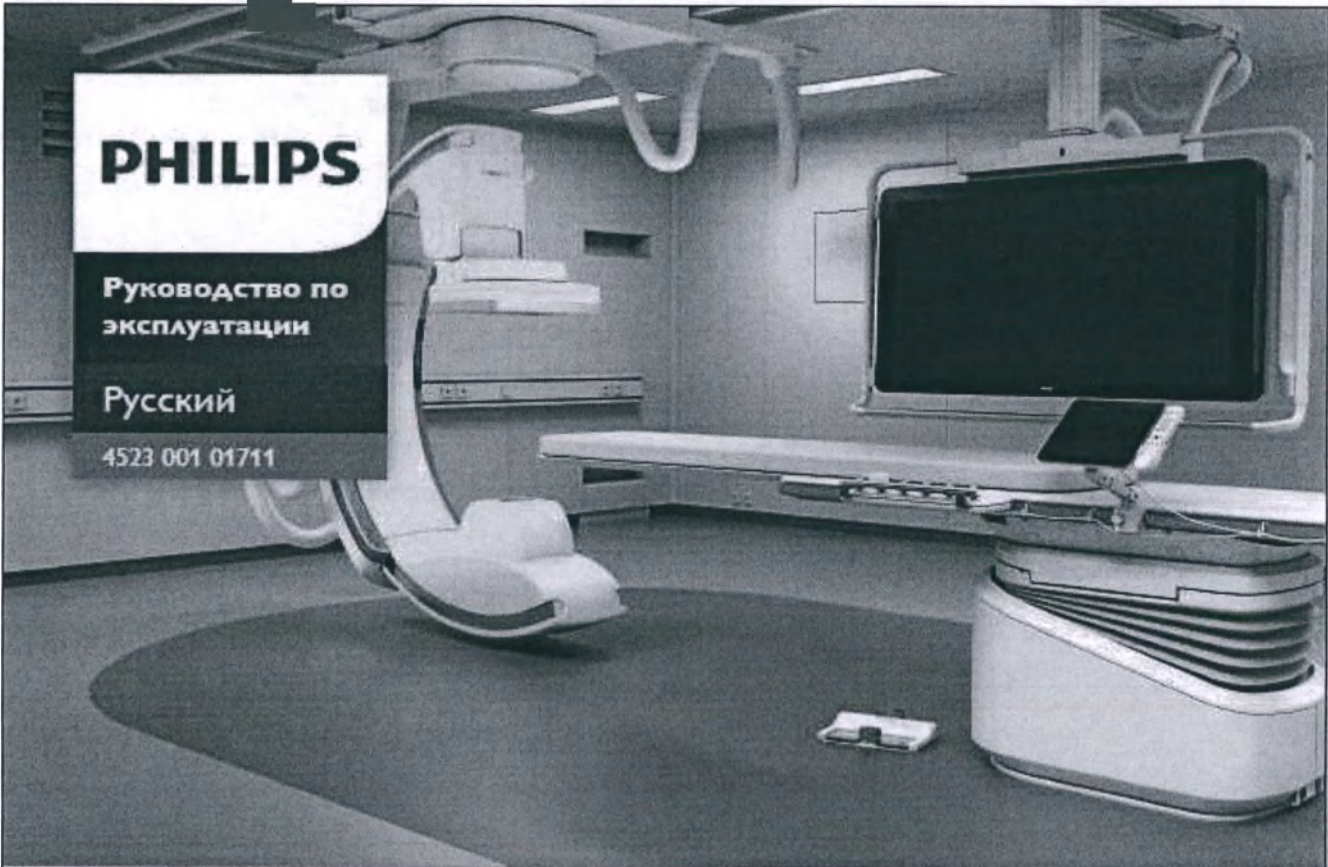

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский


4523 001 01711

Philips Azurion


Версия 2.2

21. б. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.


Система ангиографическая Azurion 5 M20 (вариант 2), в составе:

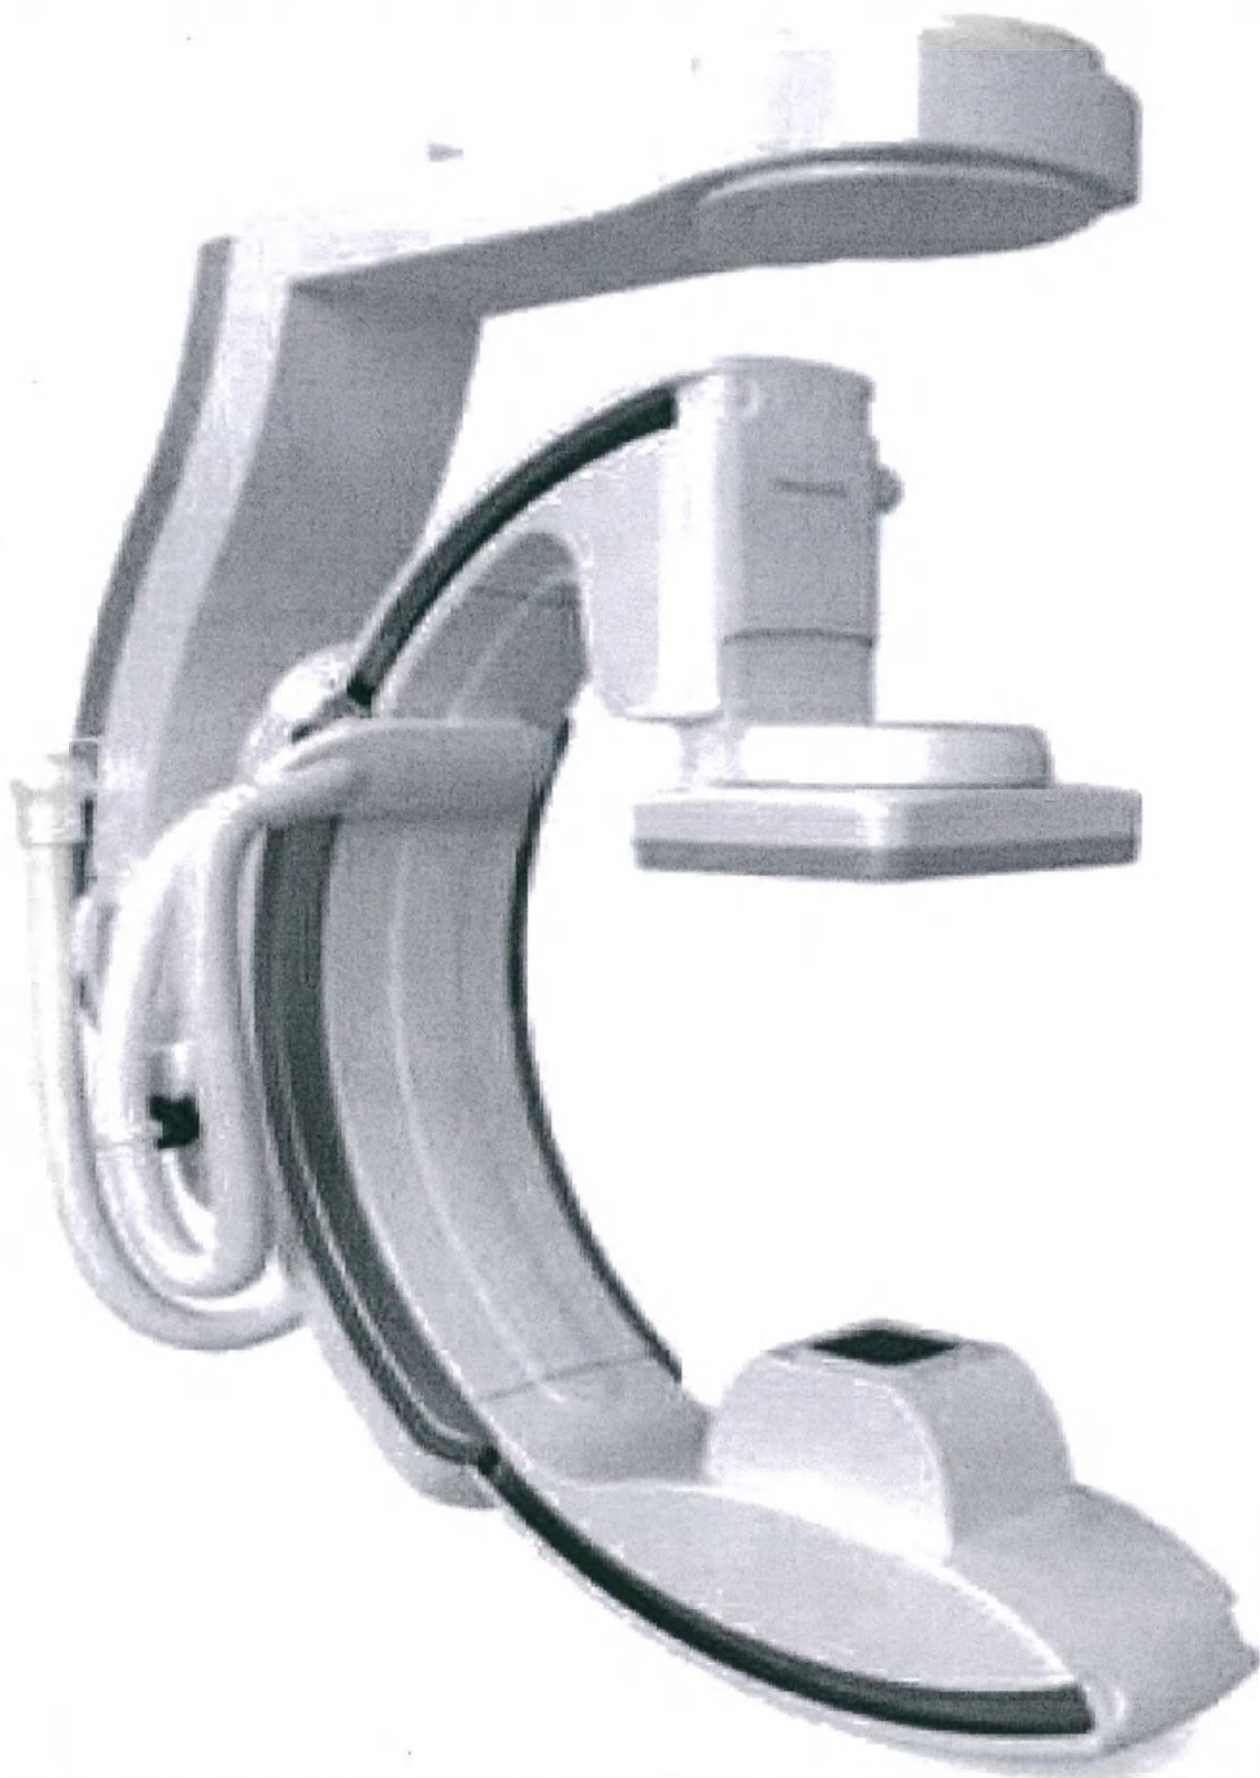


1. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C20.

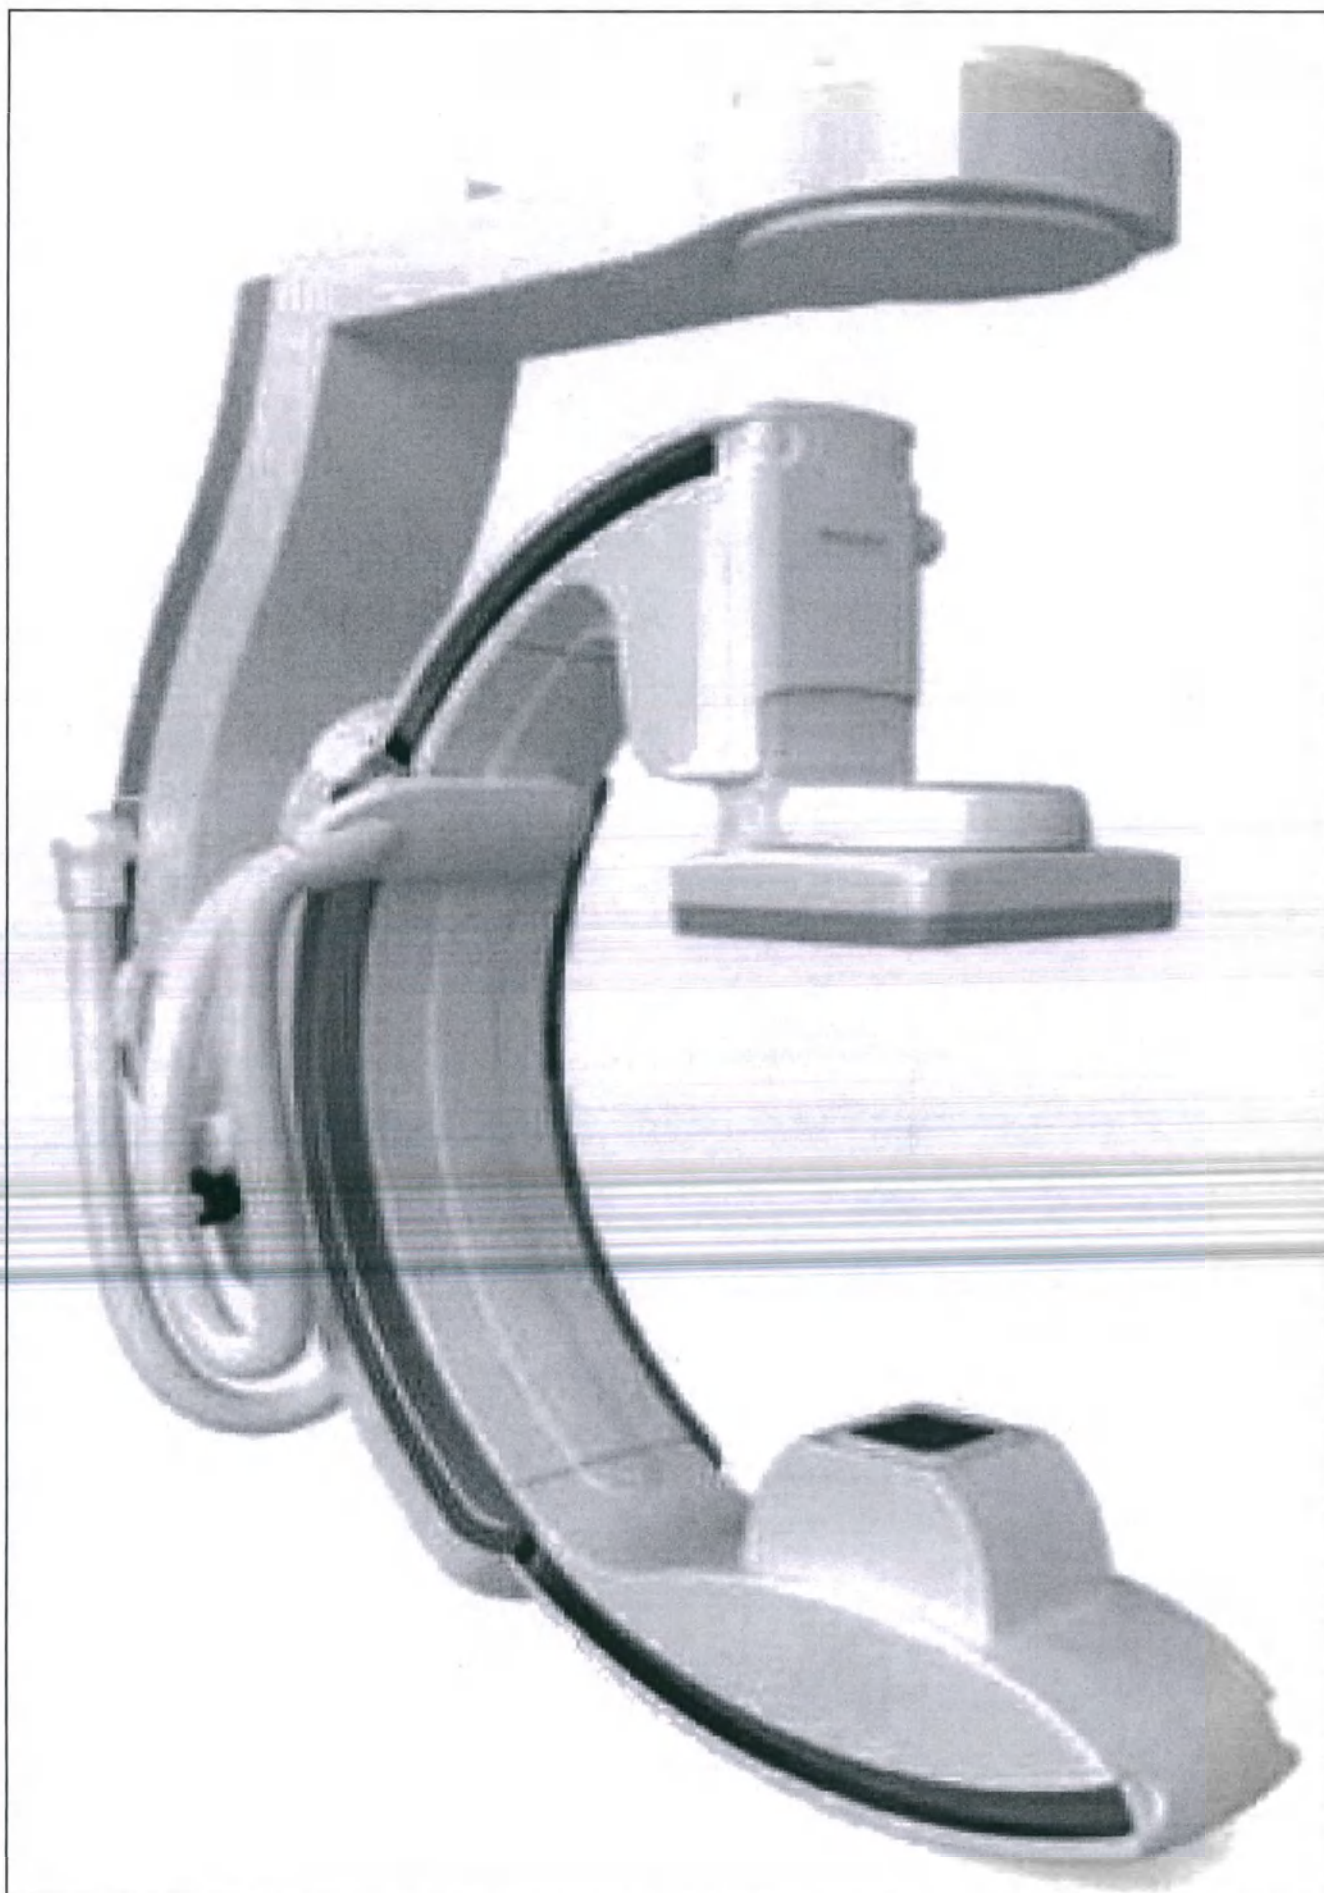


1.а. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

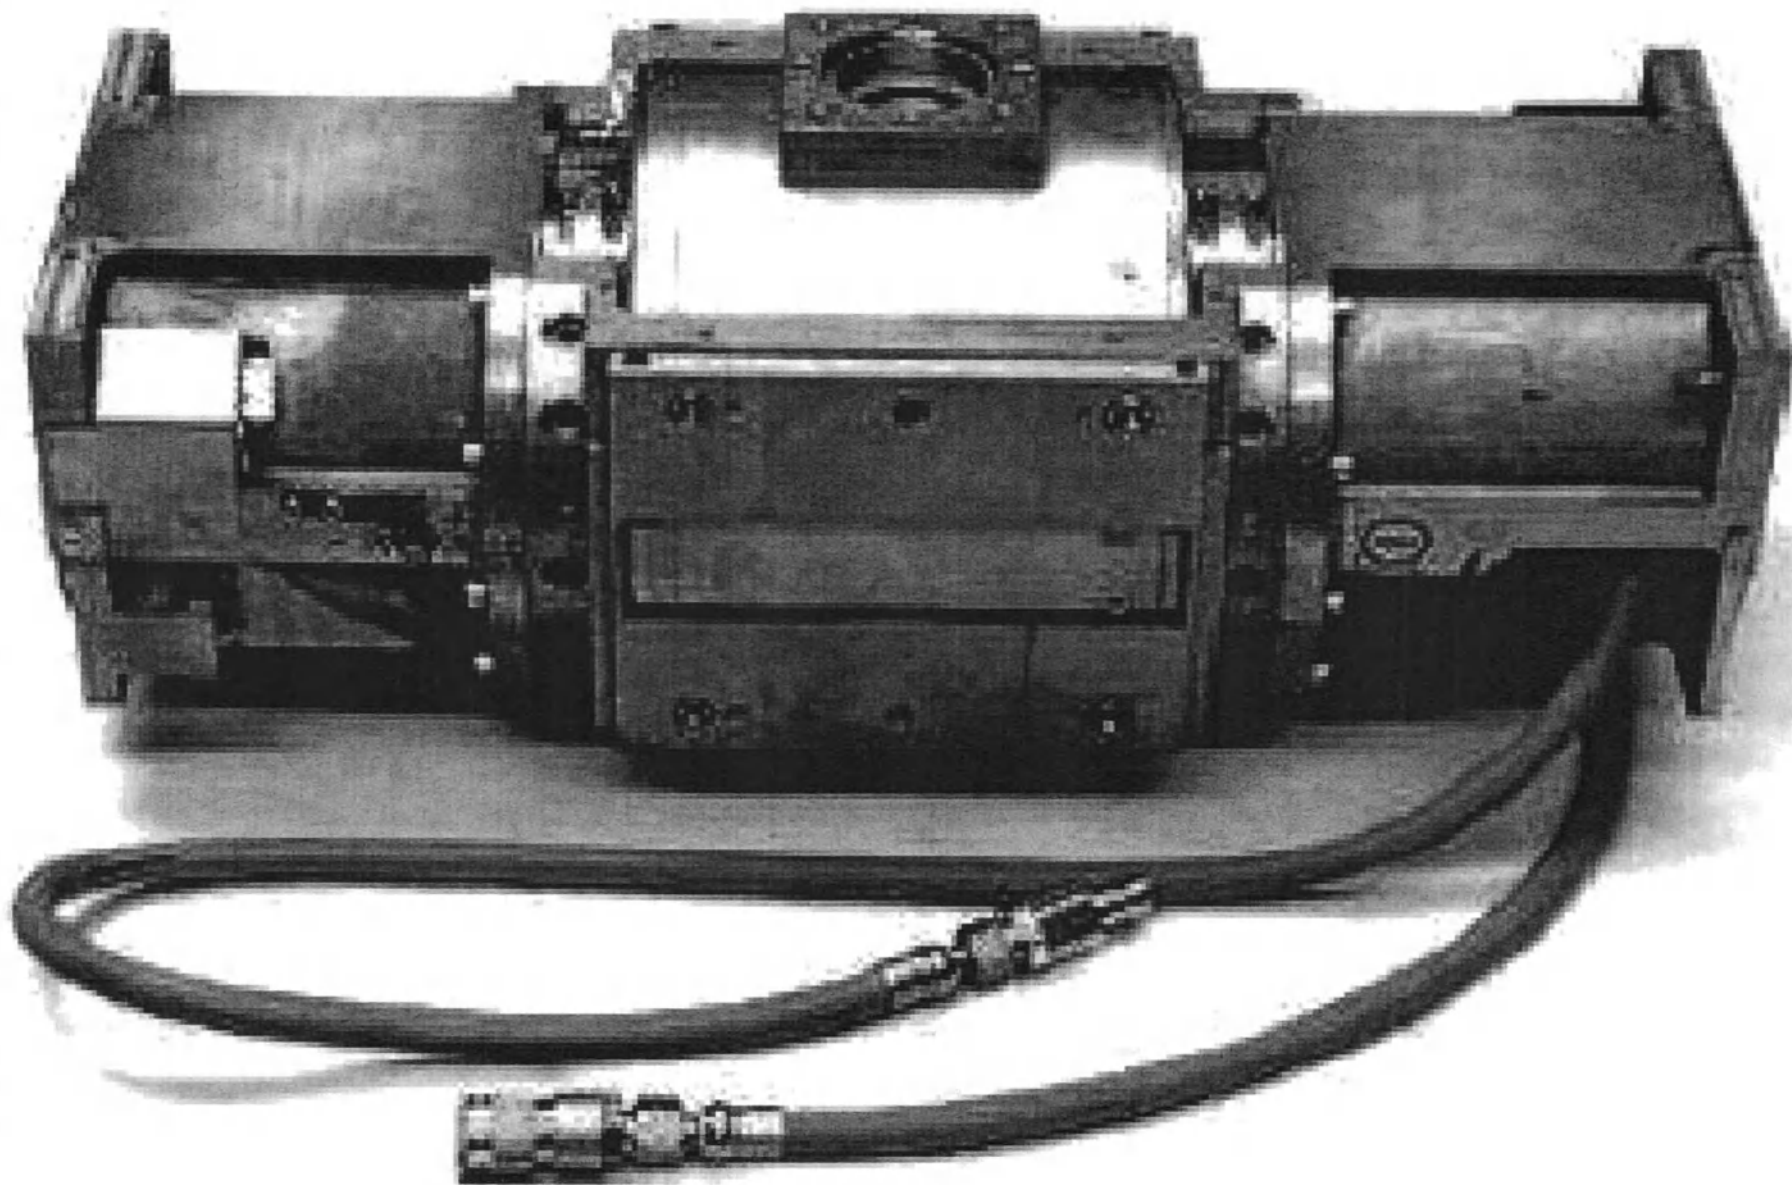


1.6. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор C20.

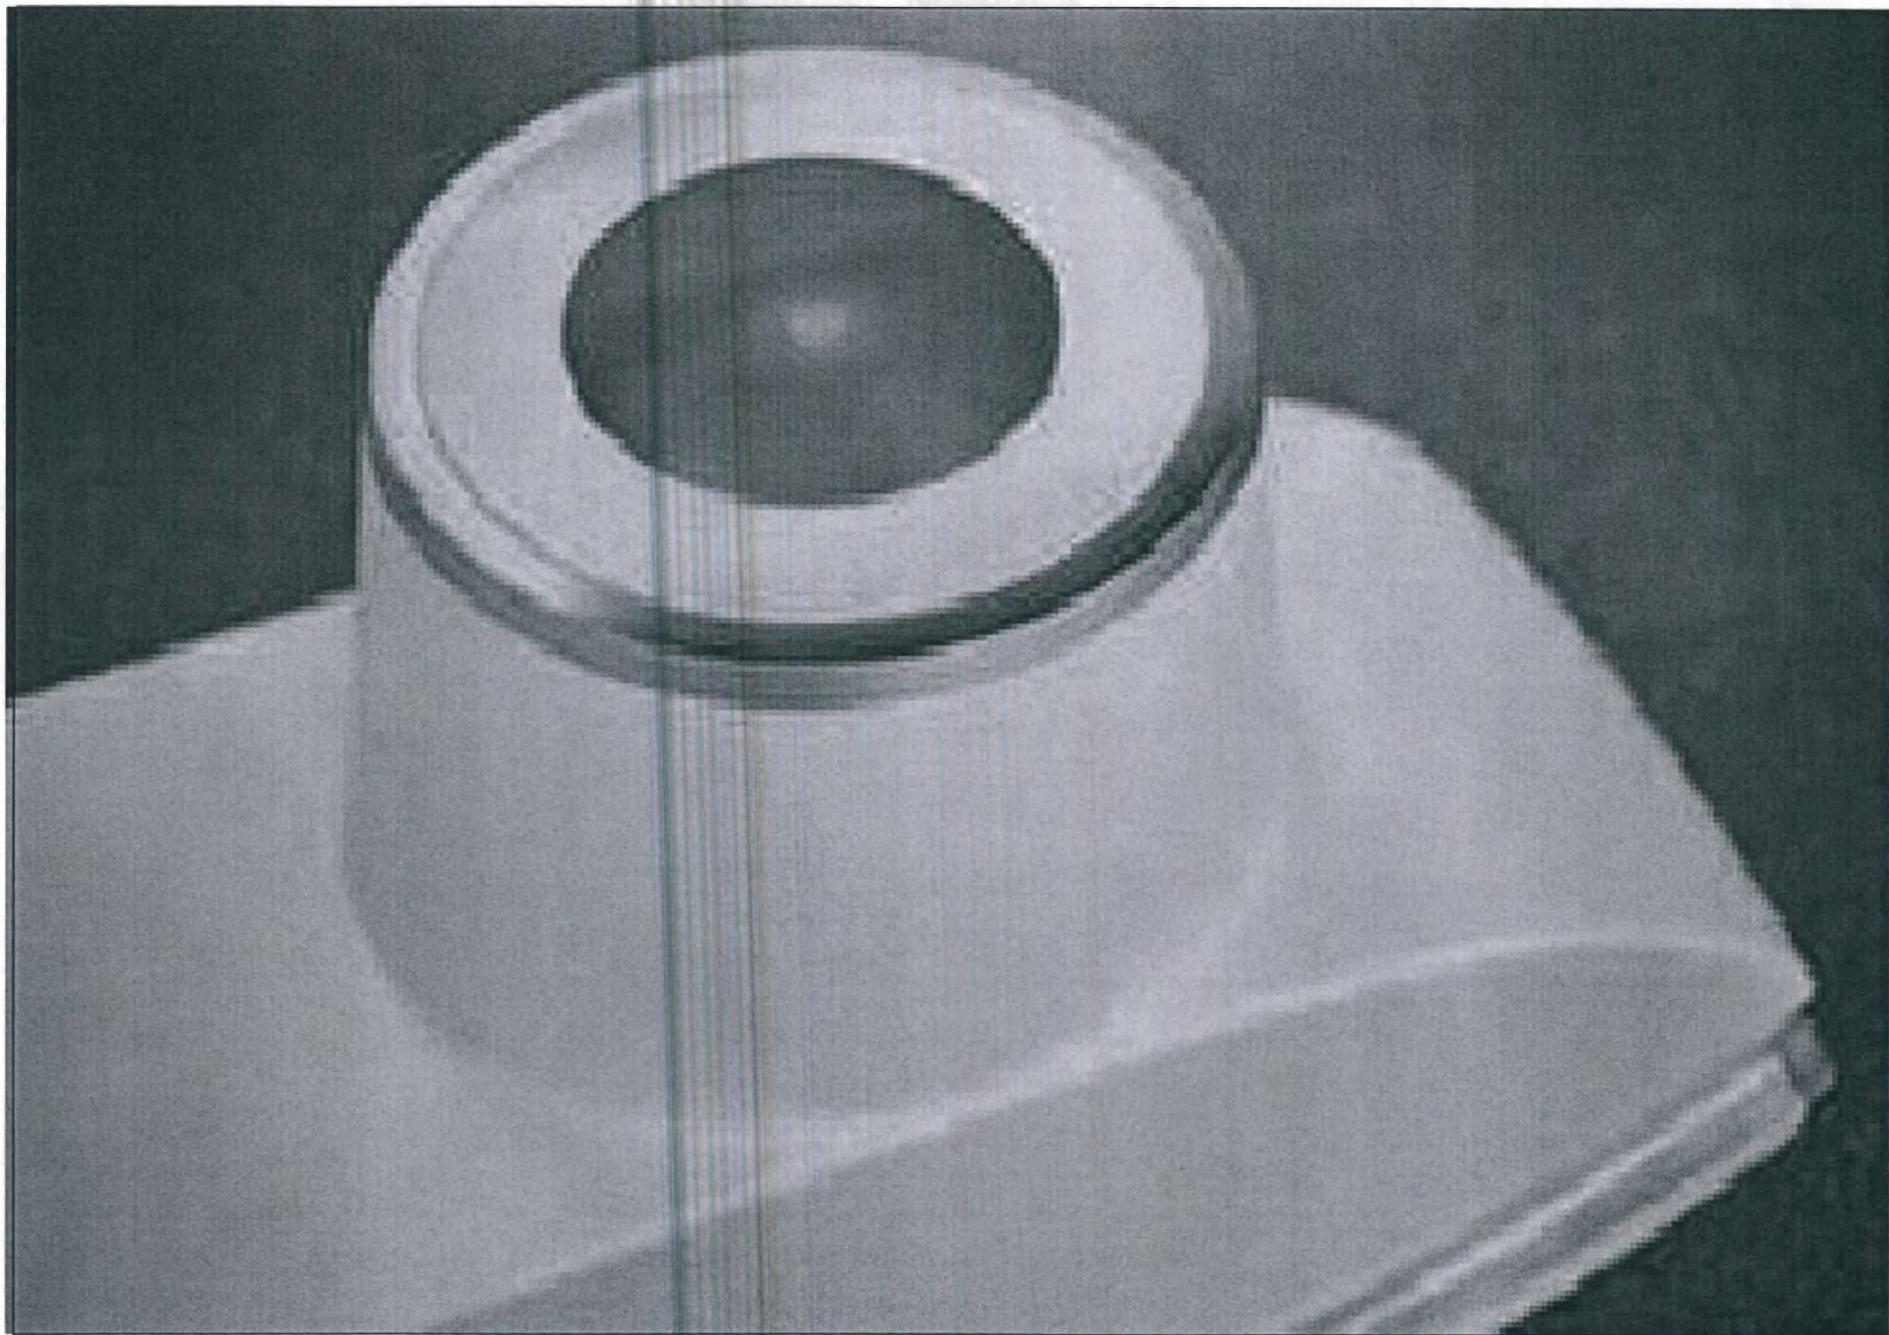


1.в. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

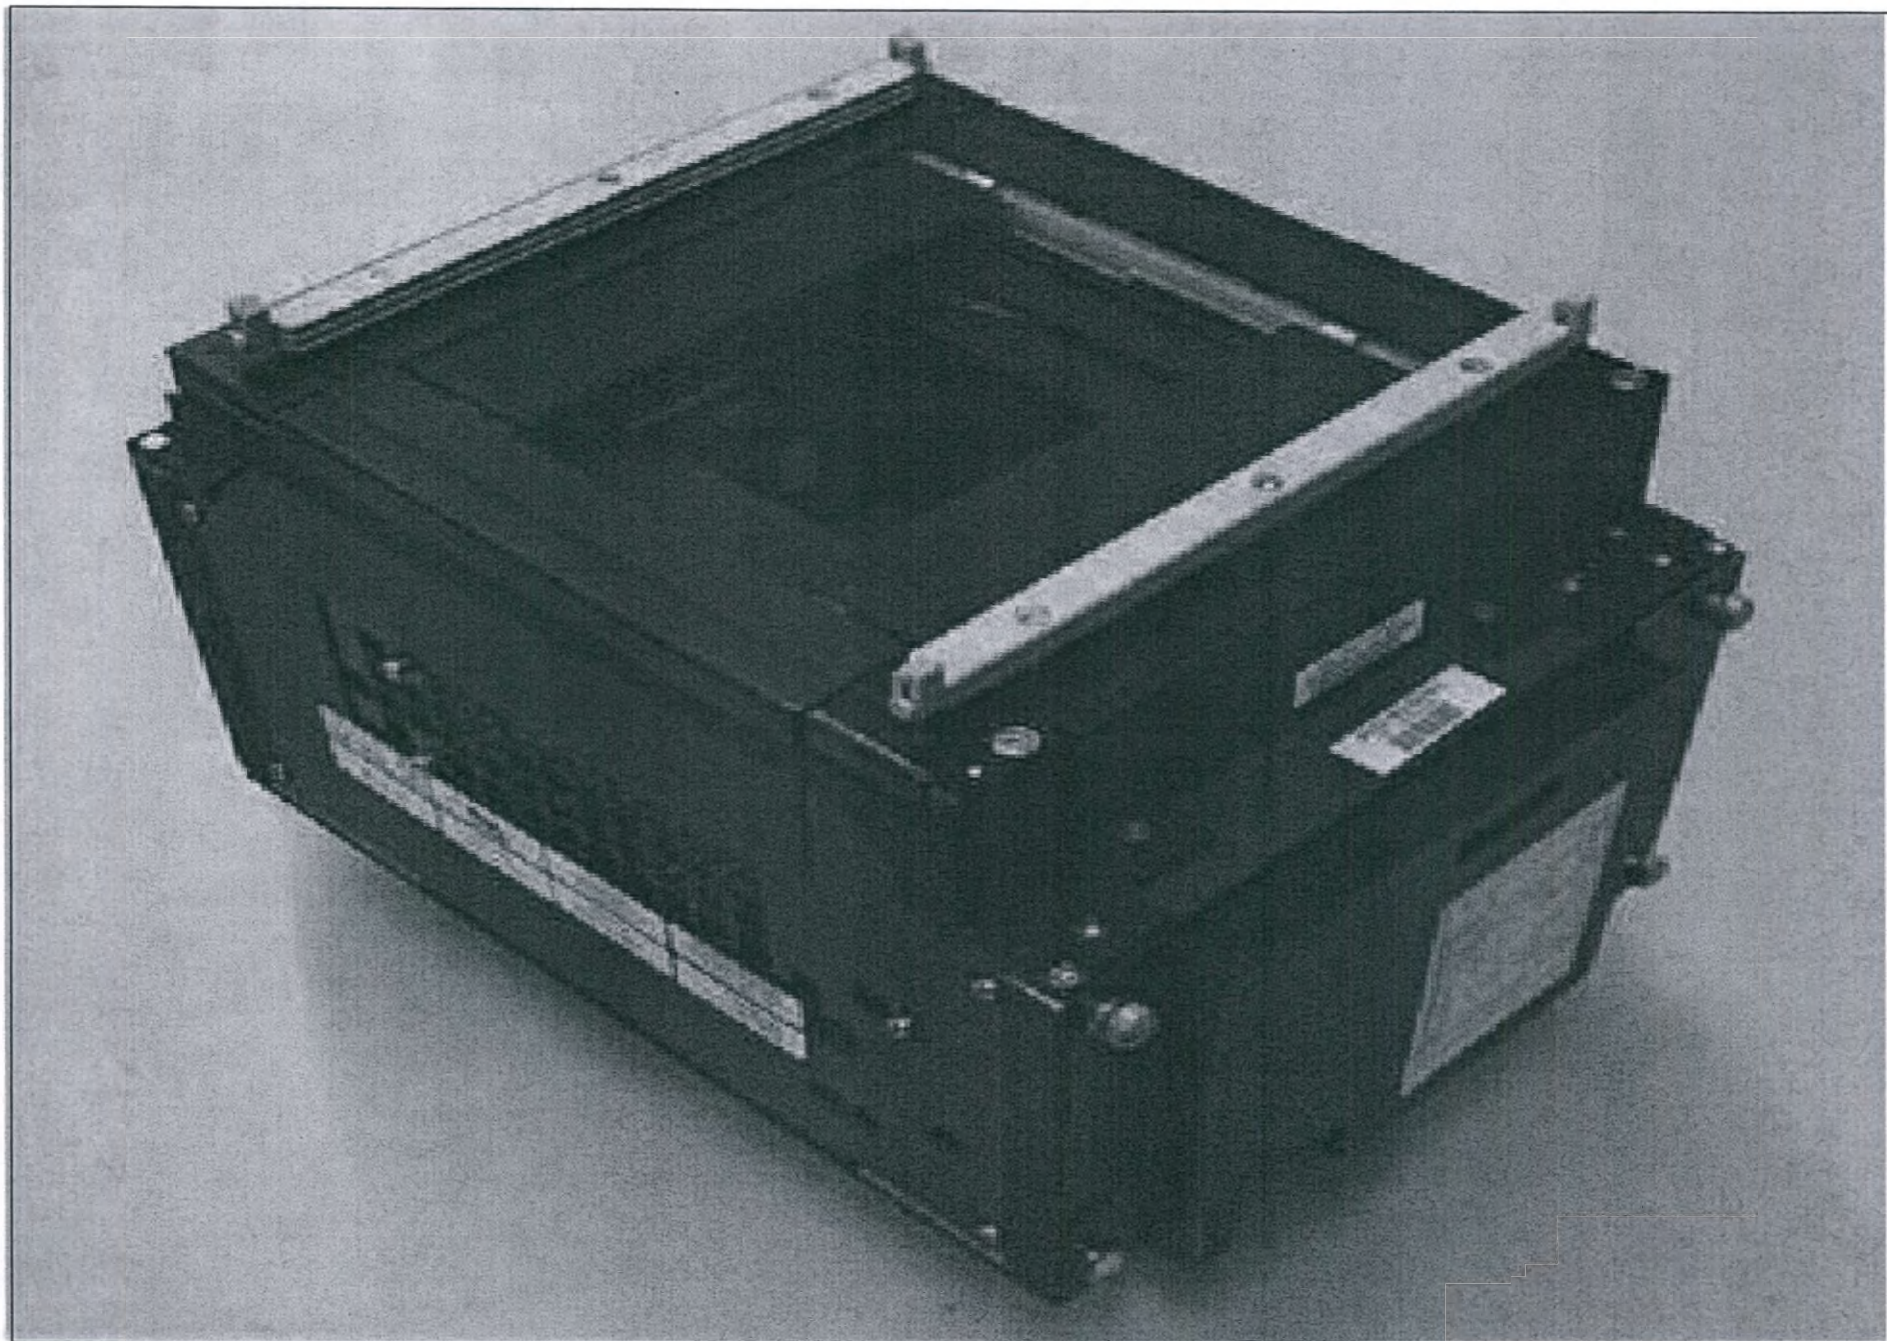


1.2. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

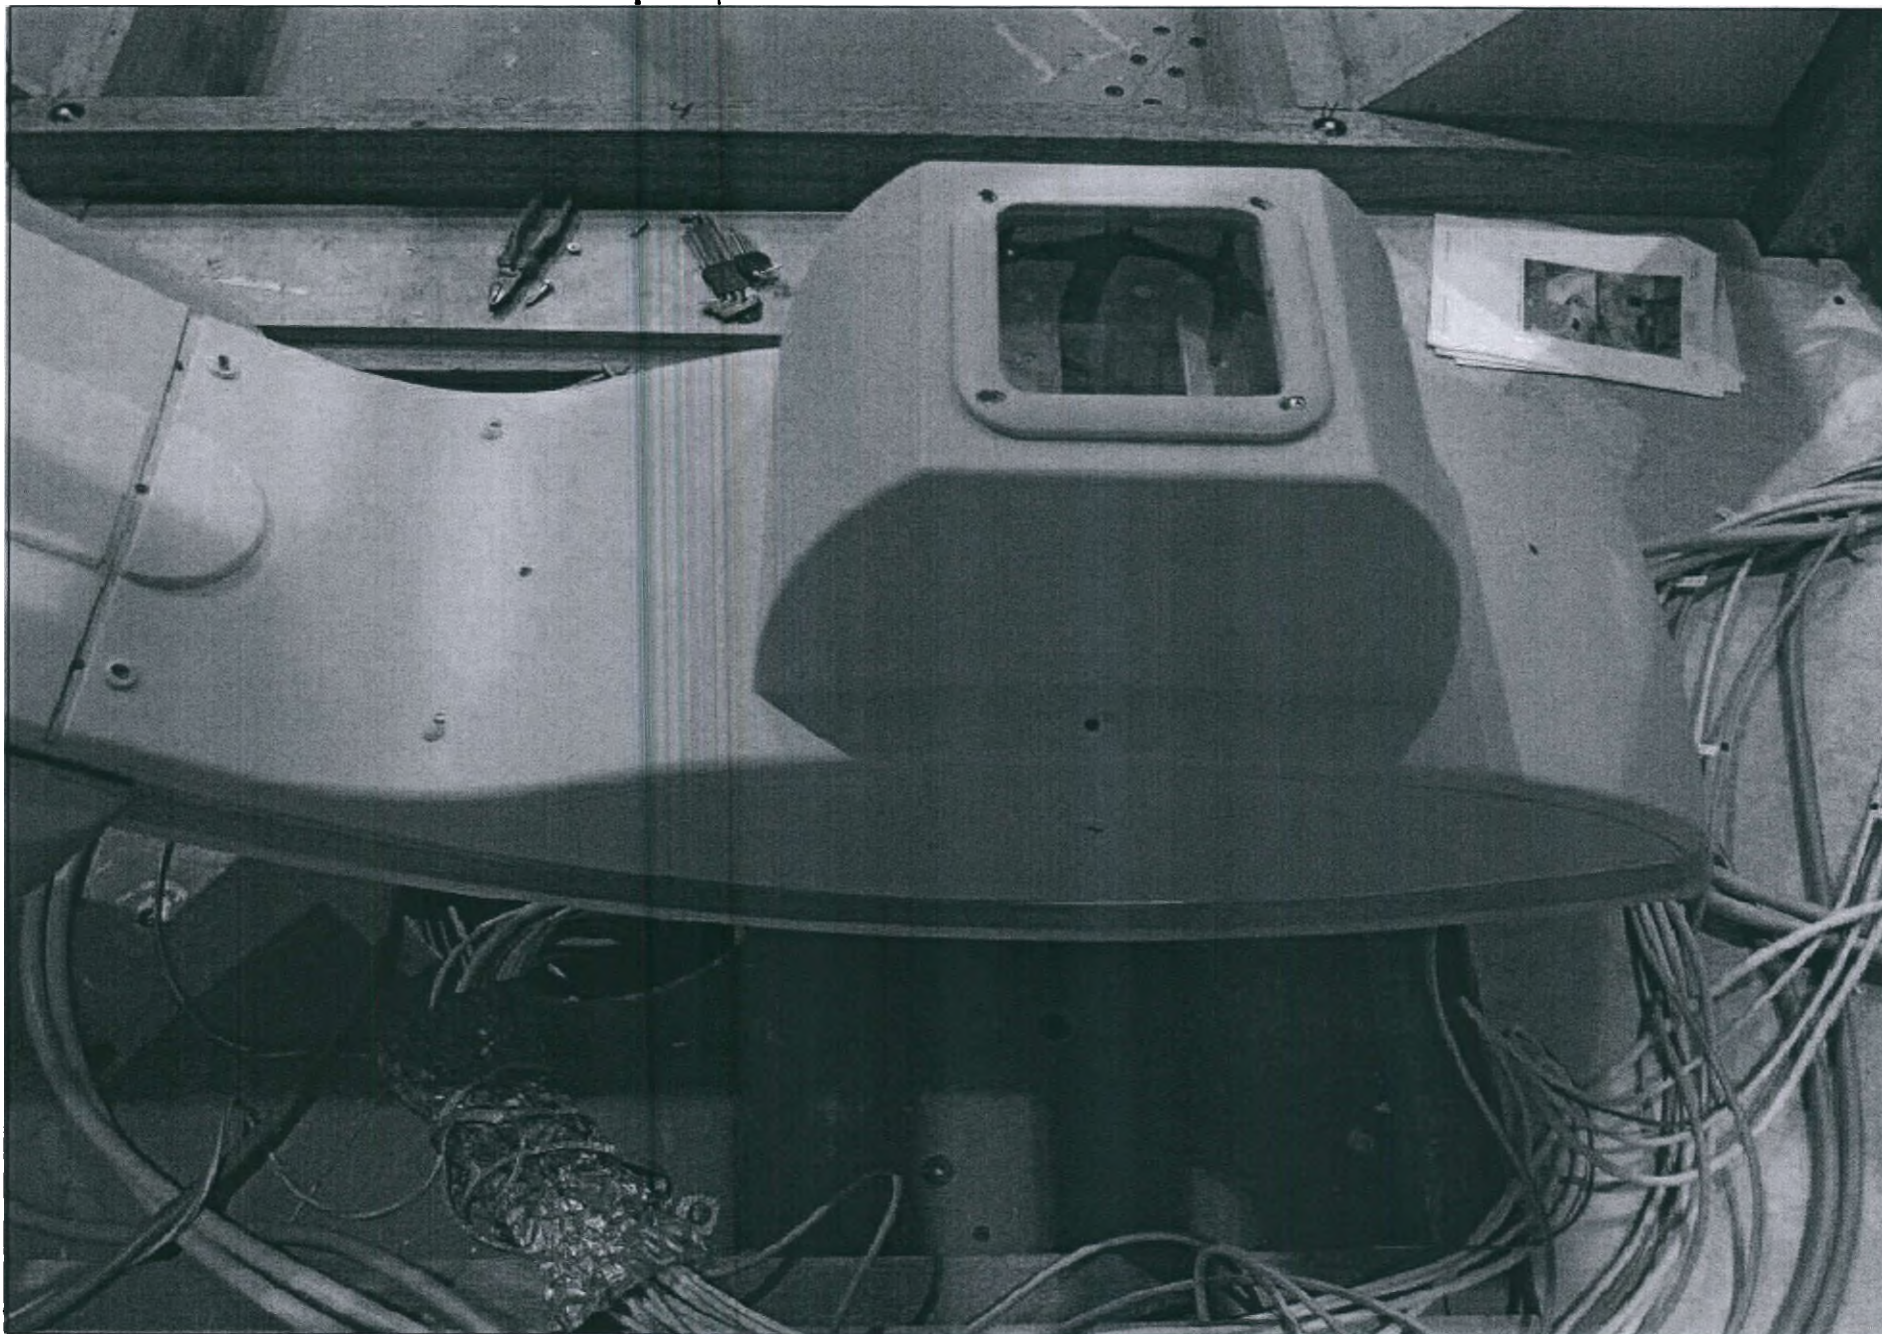


1.д. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

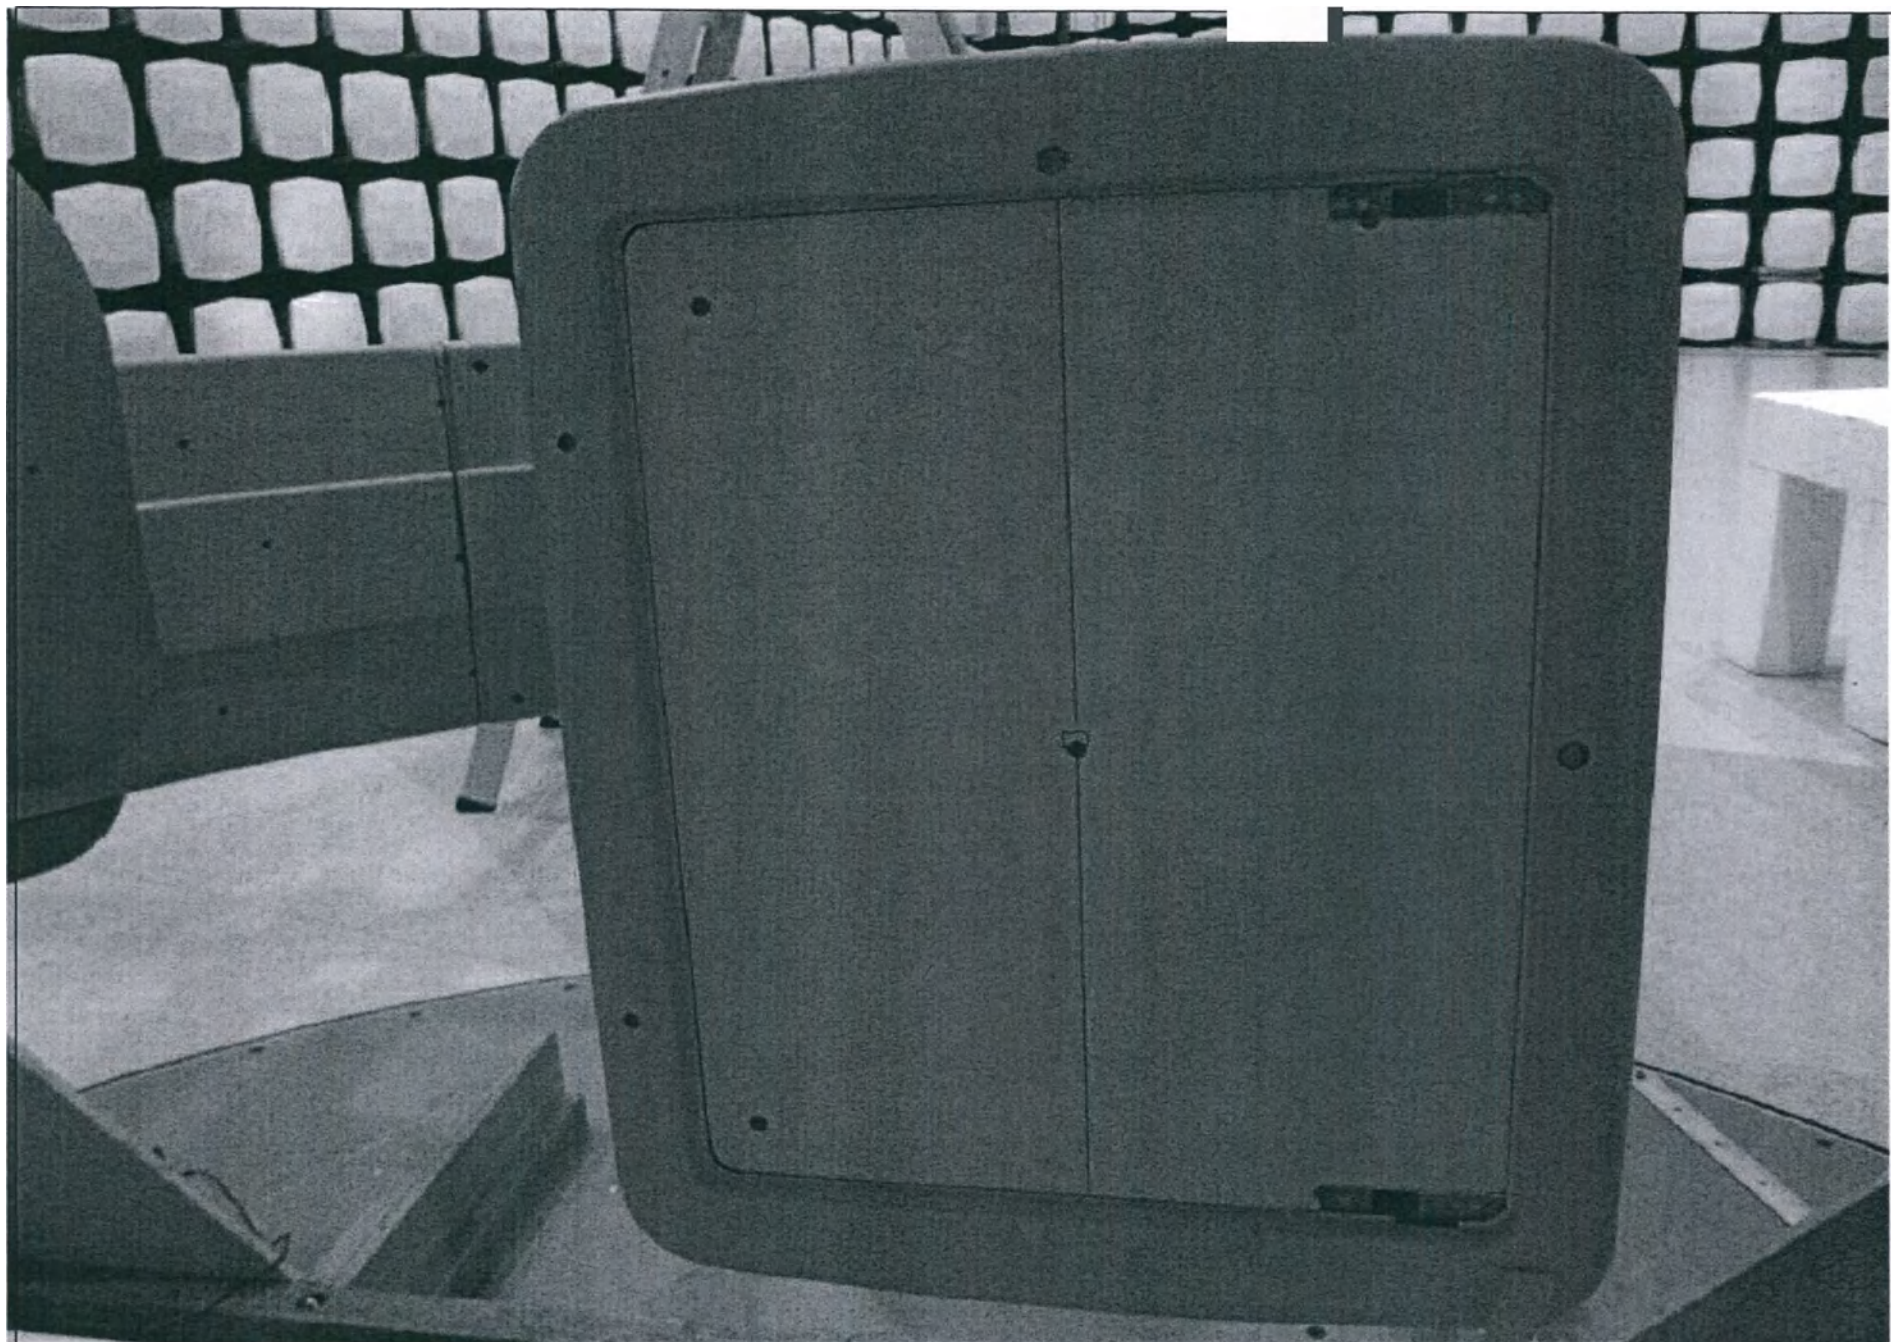


1.е. Модуль С-дуги напольный в составе: штатив с потолочным креплением С-дуги; С-дуга; рентгеновский излучатель; коллиматор; детектор С20.

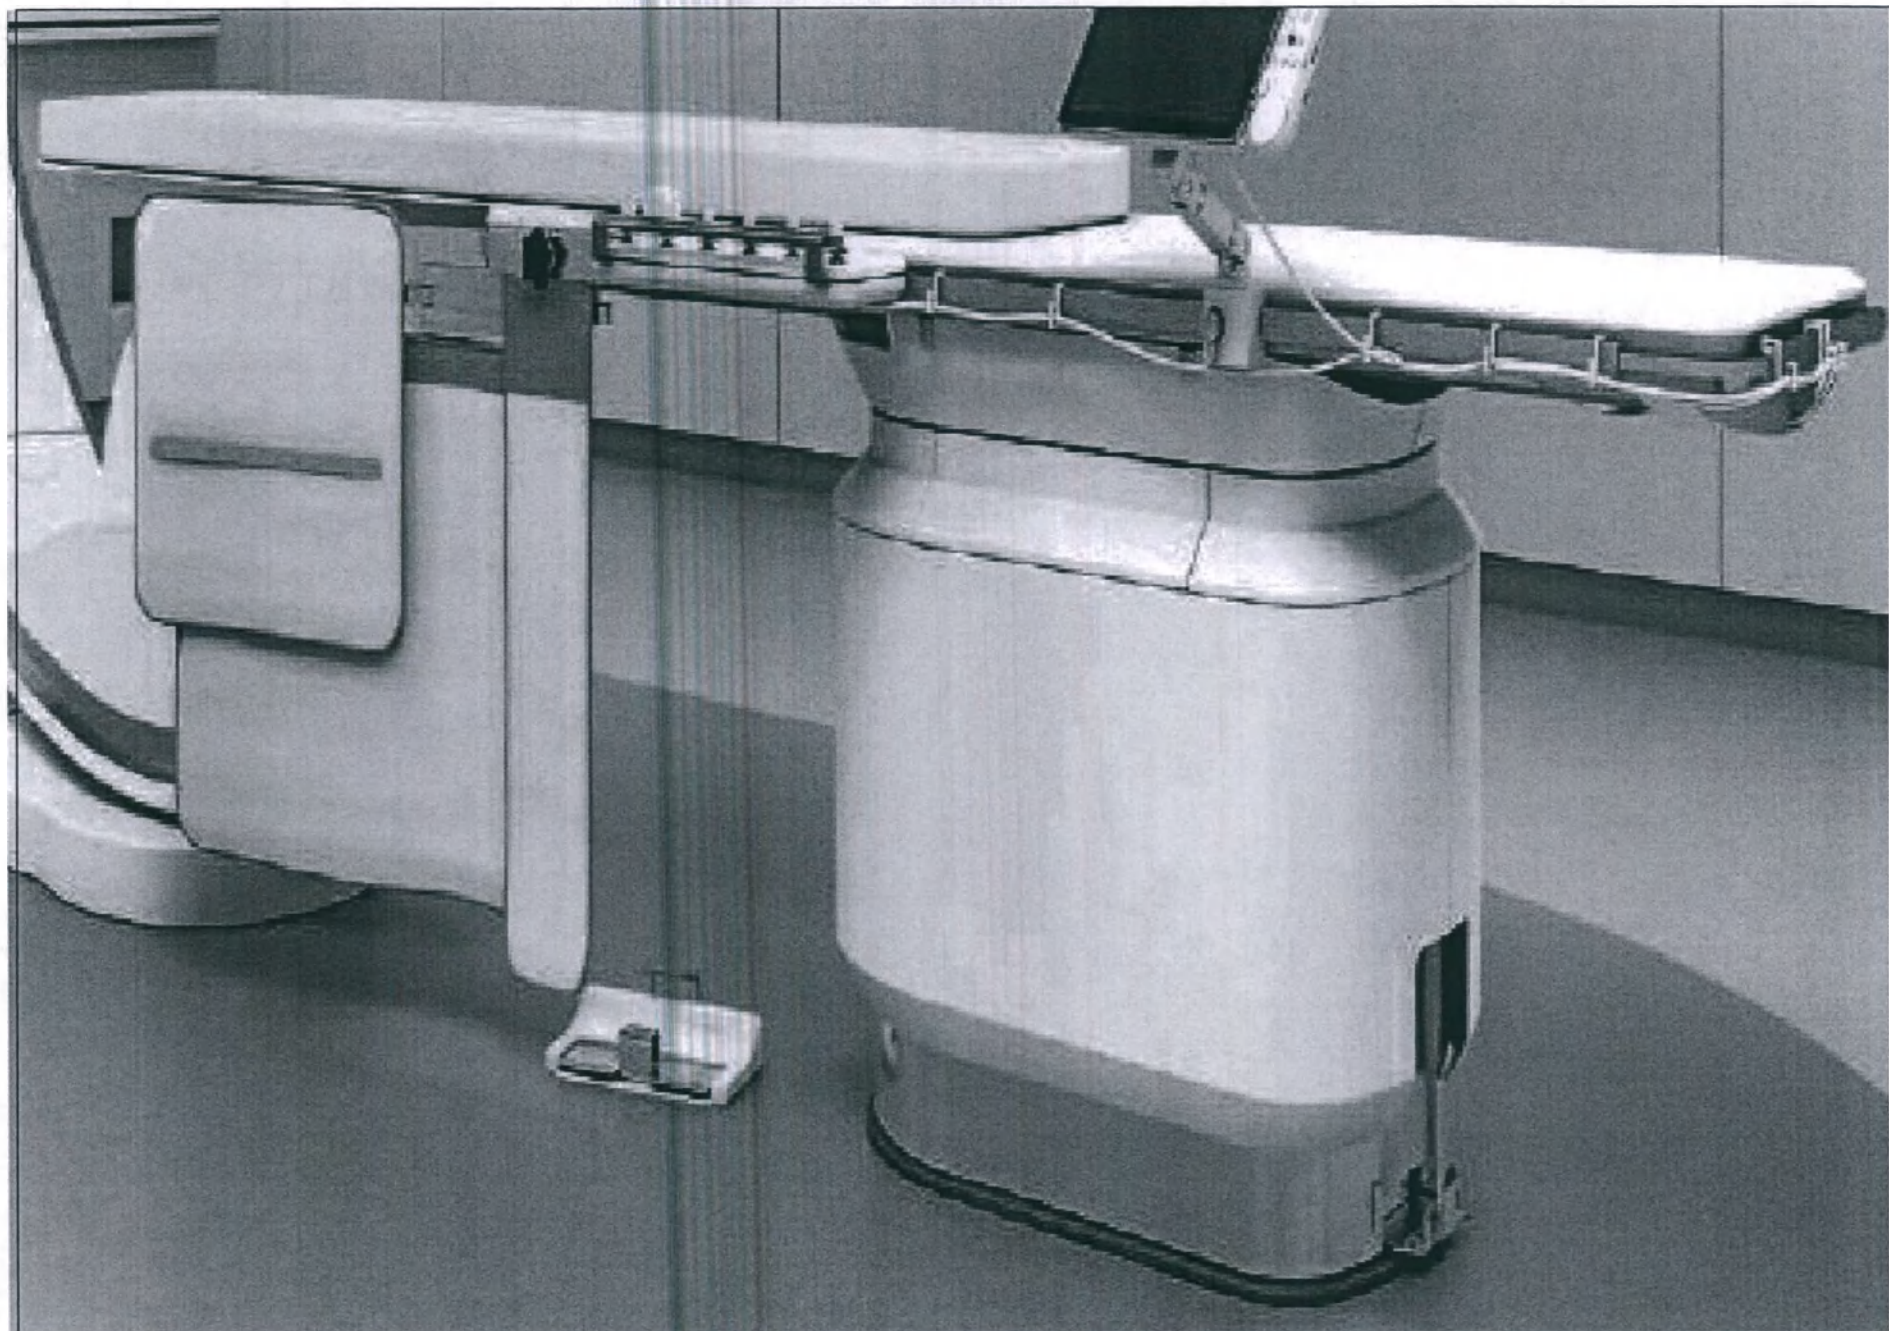


2.а. Стол пациента, варианты исполнения: *Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.*

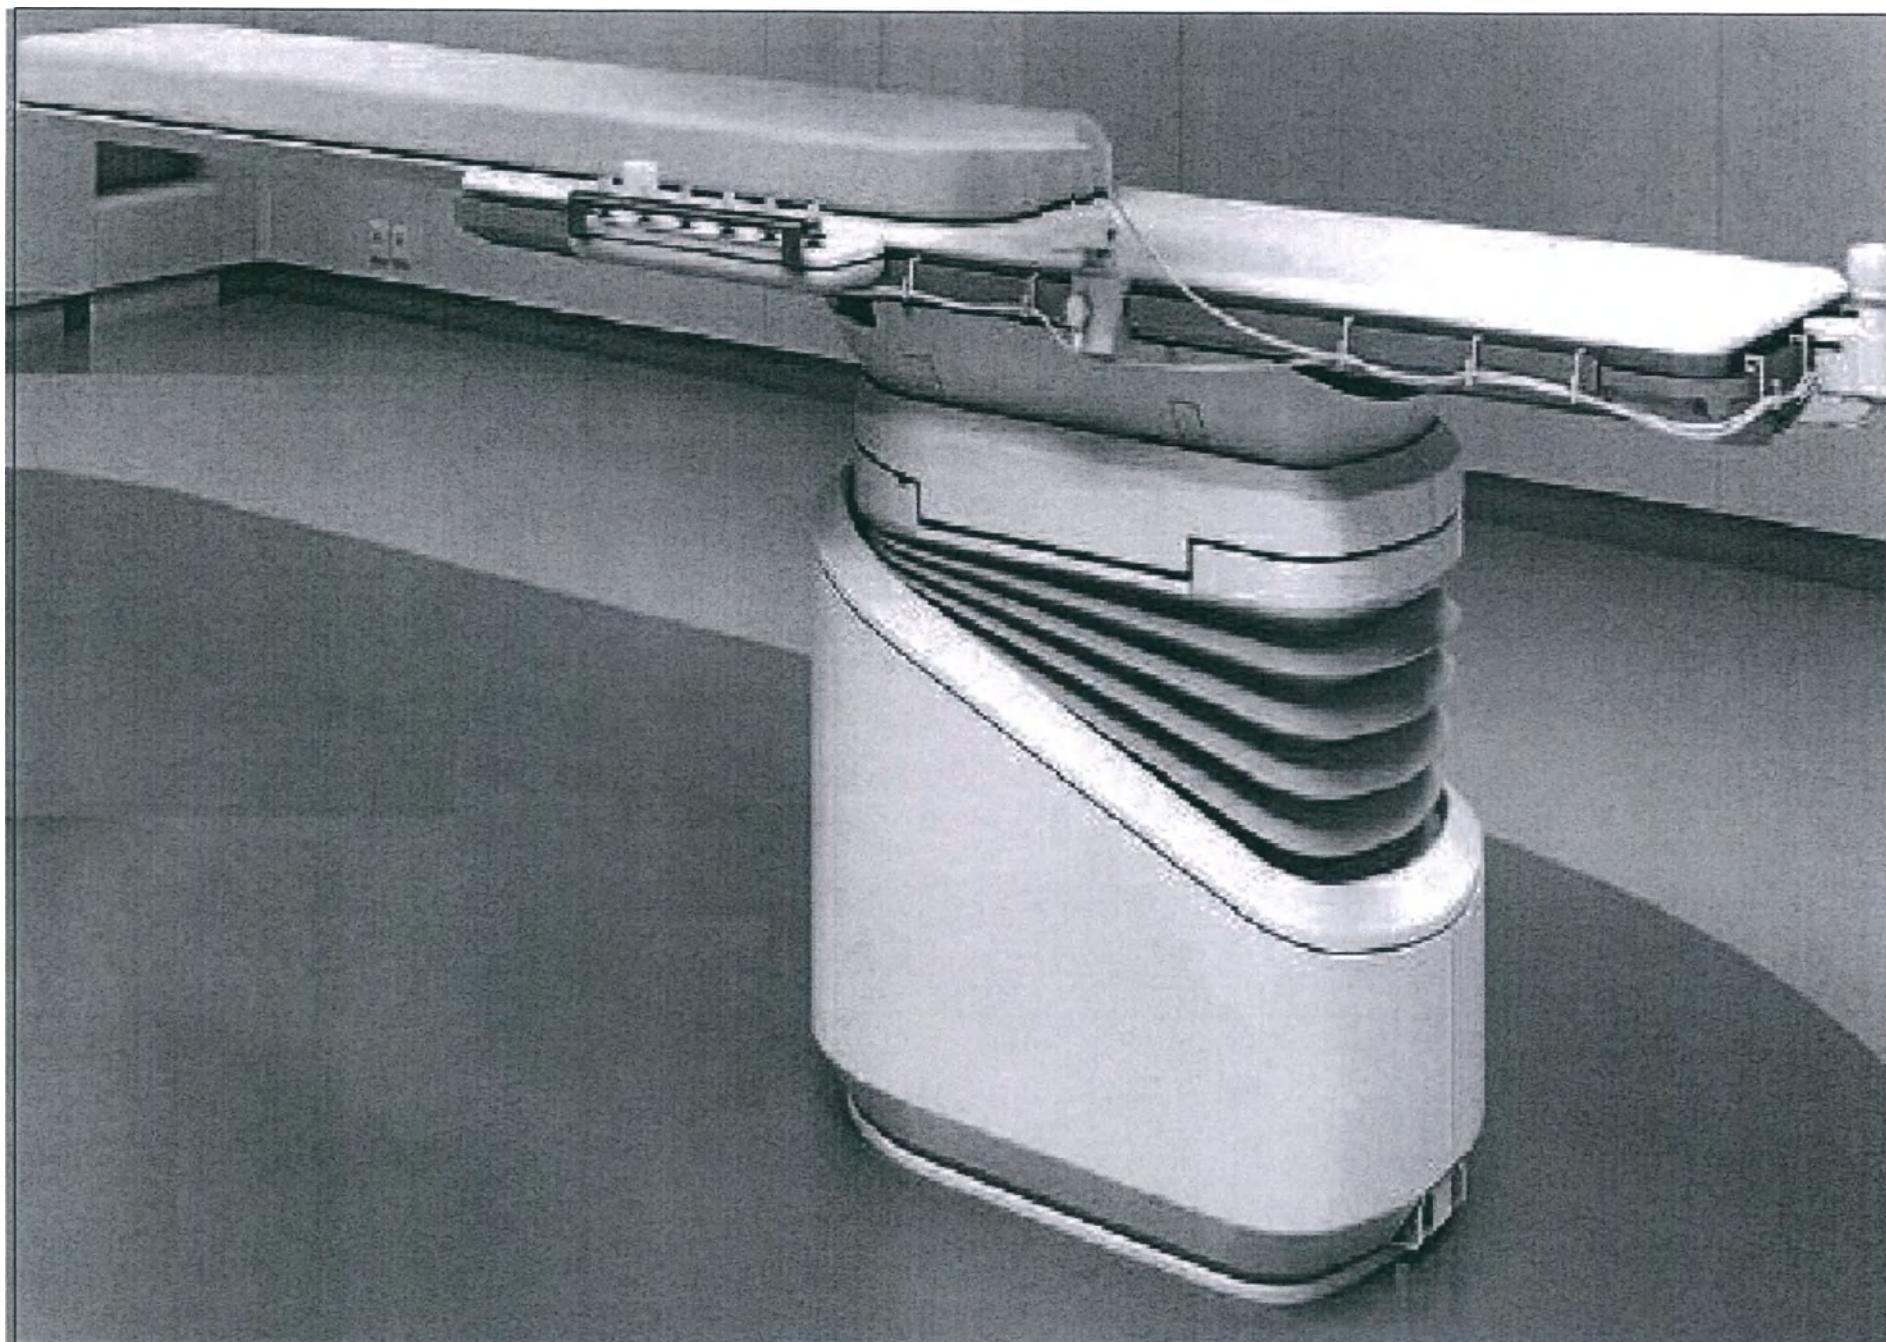


2.6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный стол пациента; Стол пациента с наклоном.

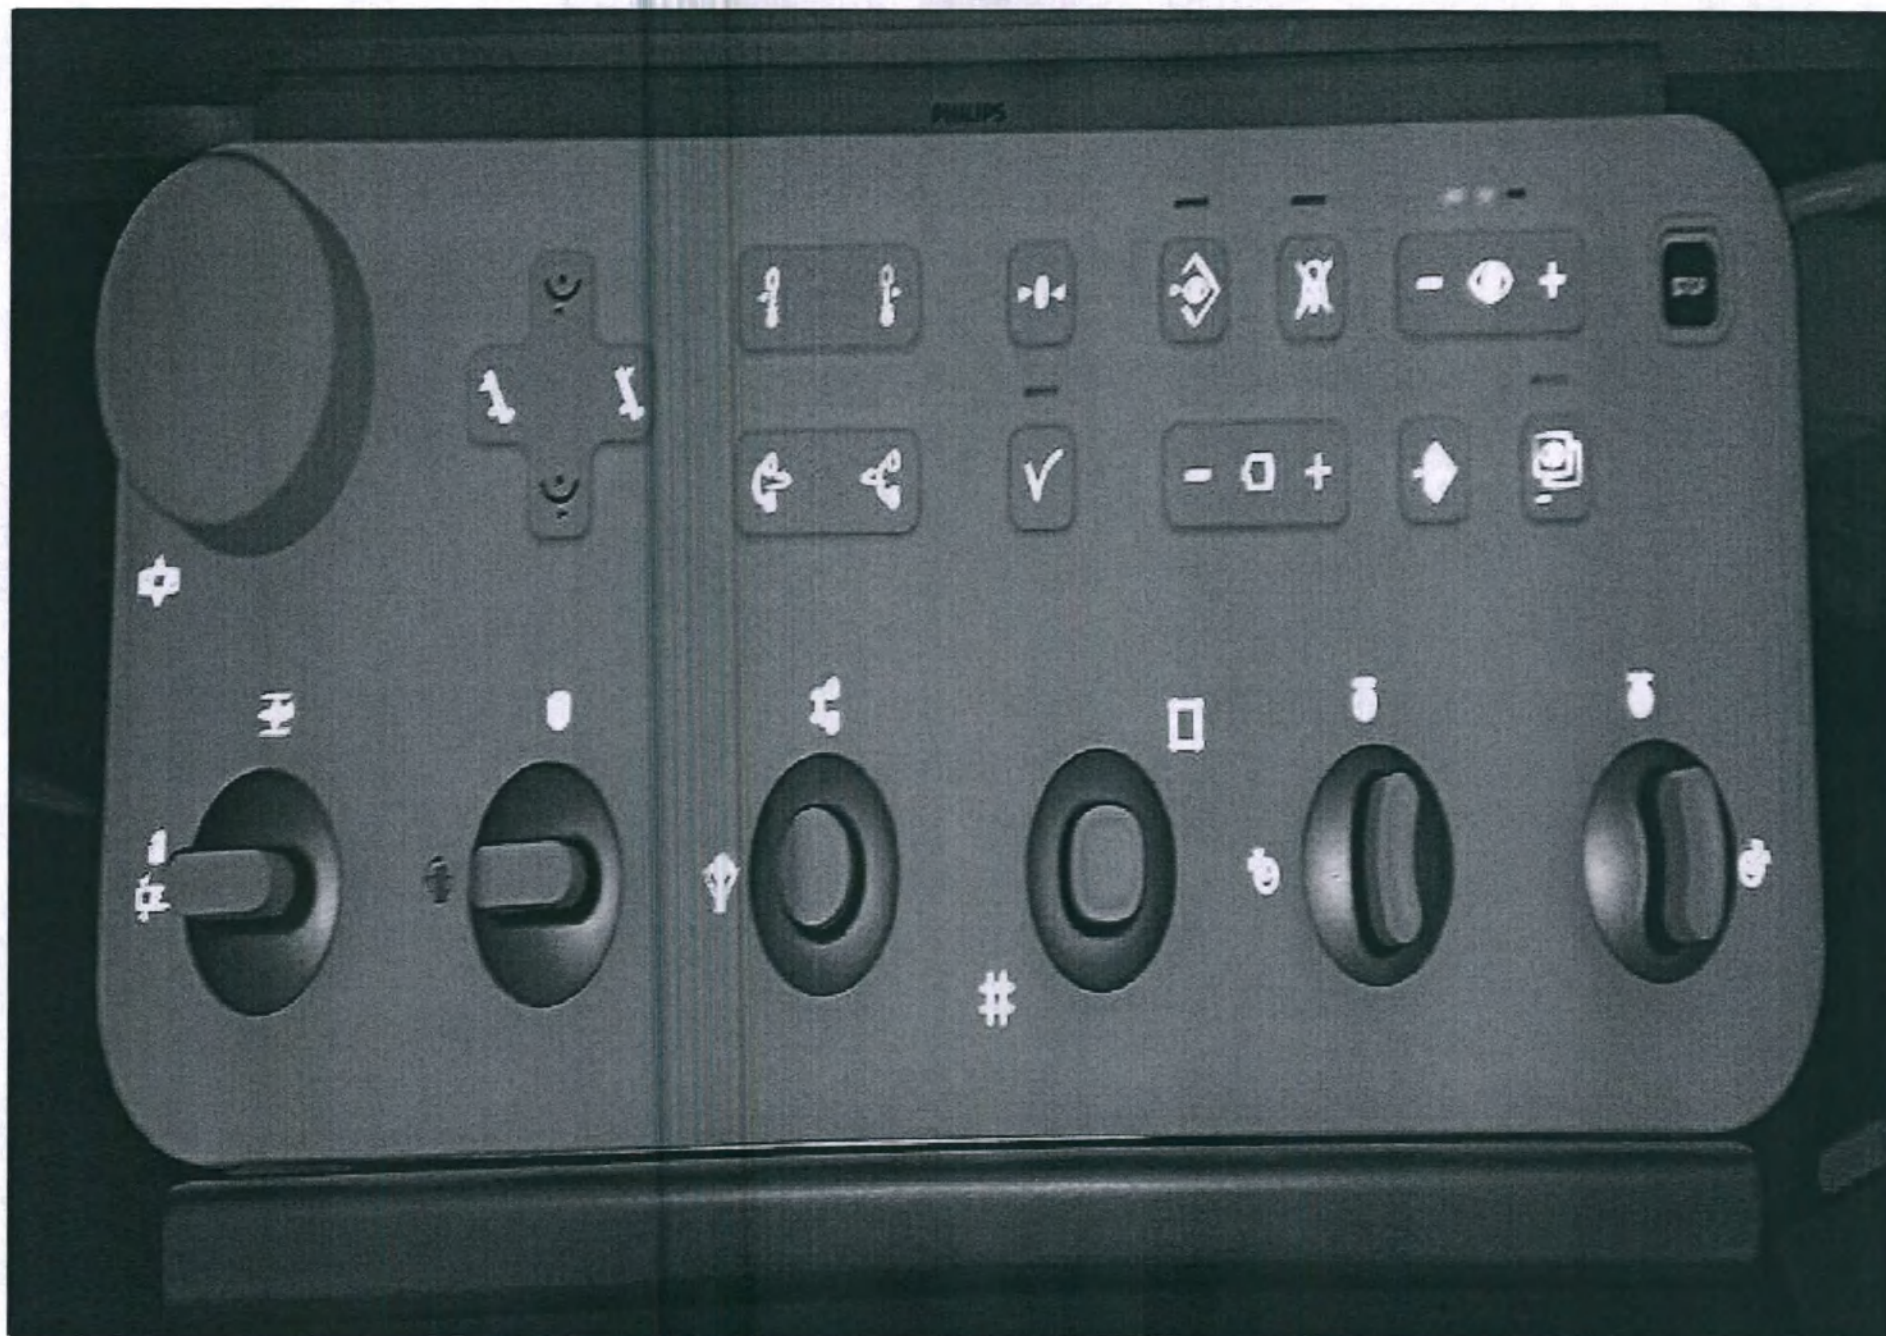

3. Модуль управления, не более 4 шт.

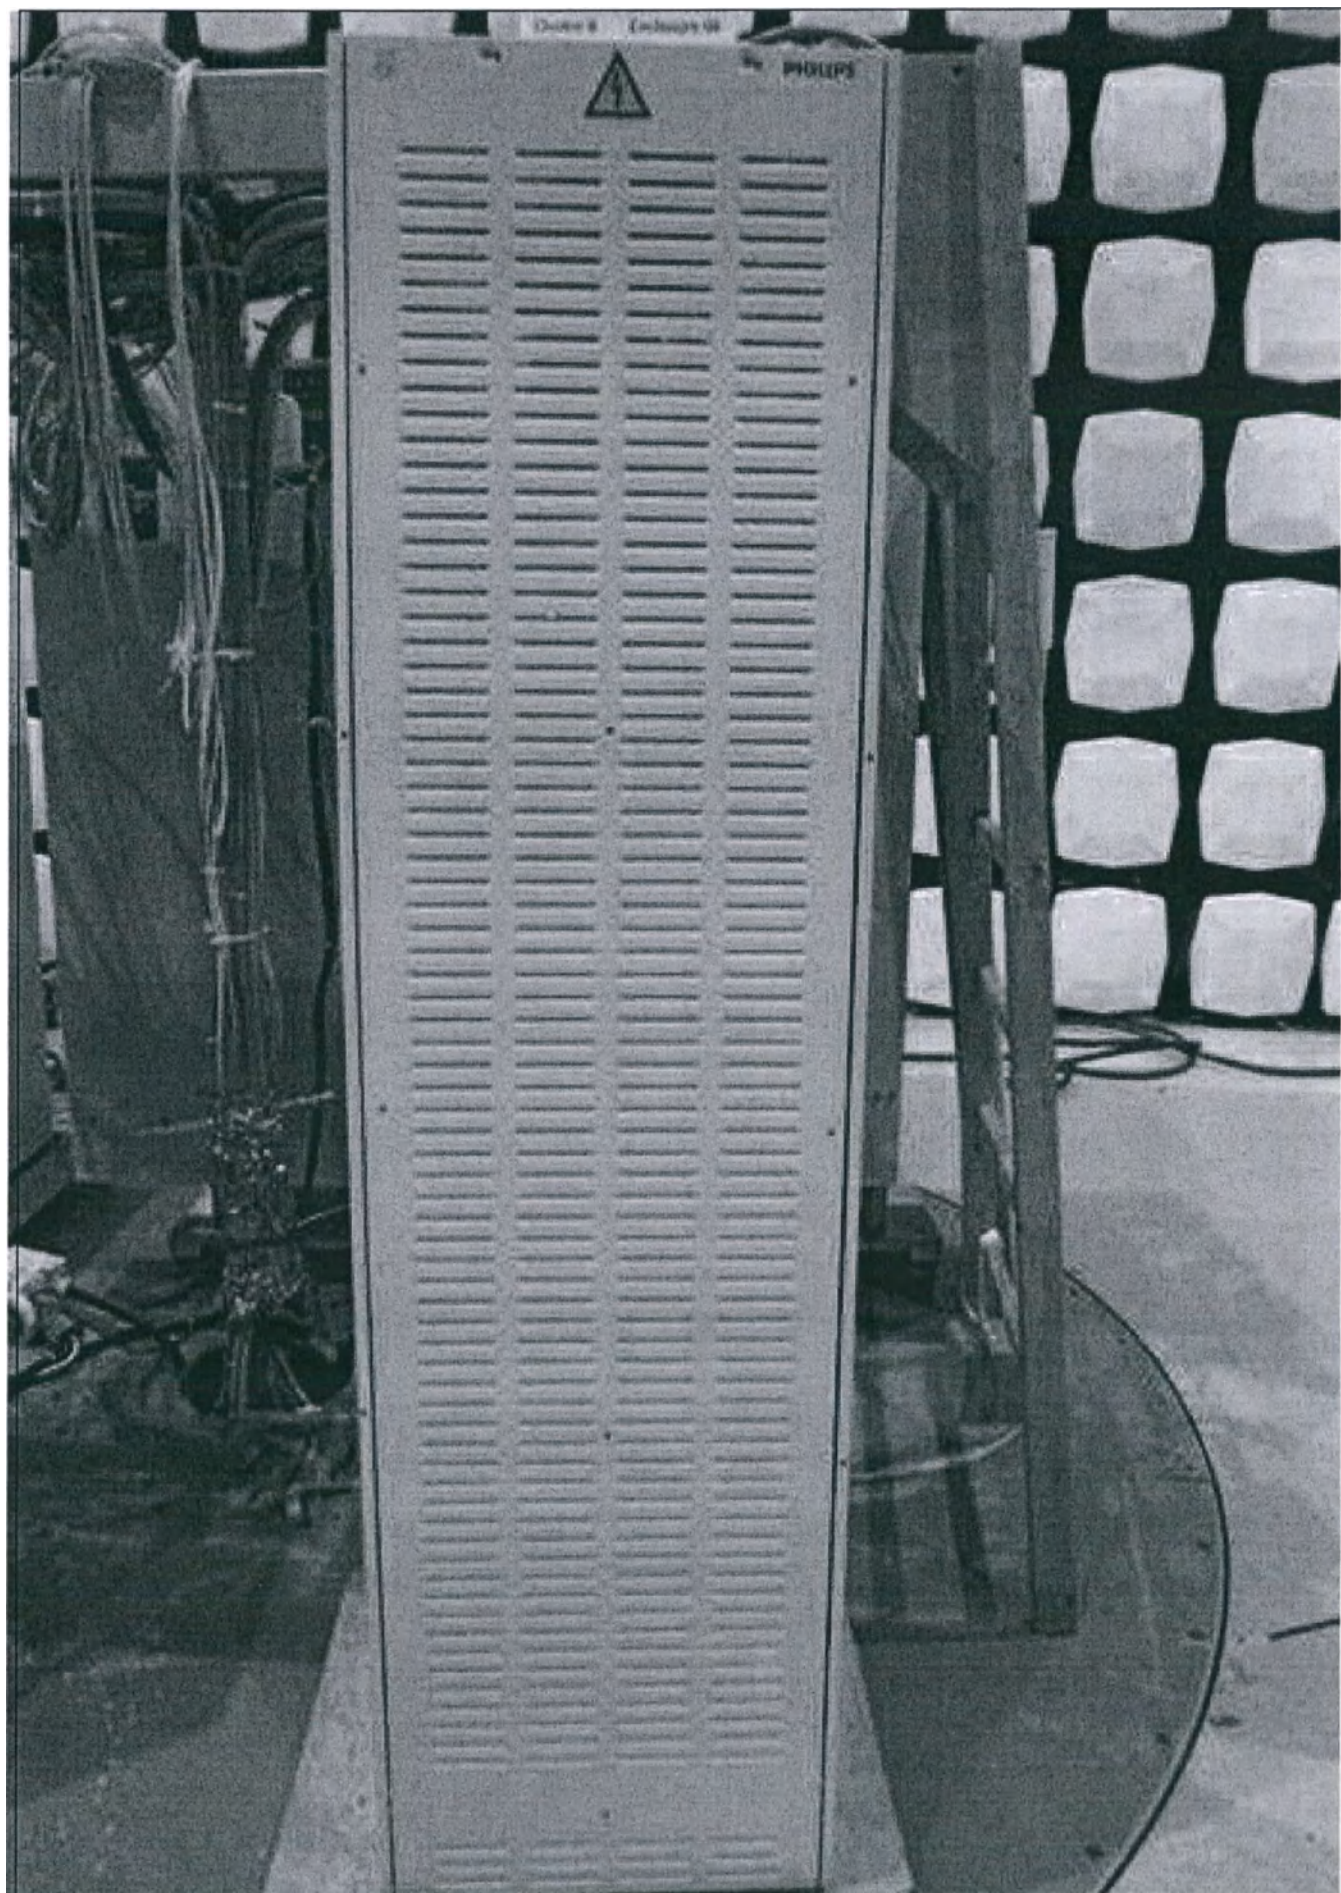


4.а. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

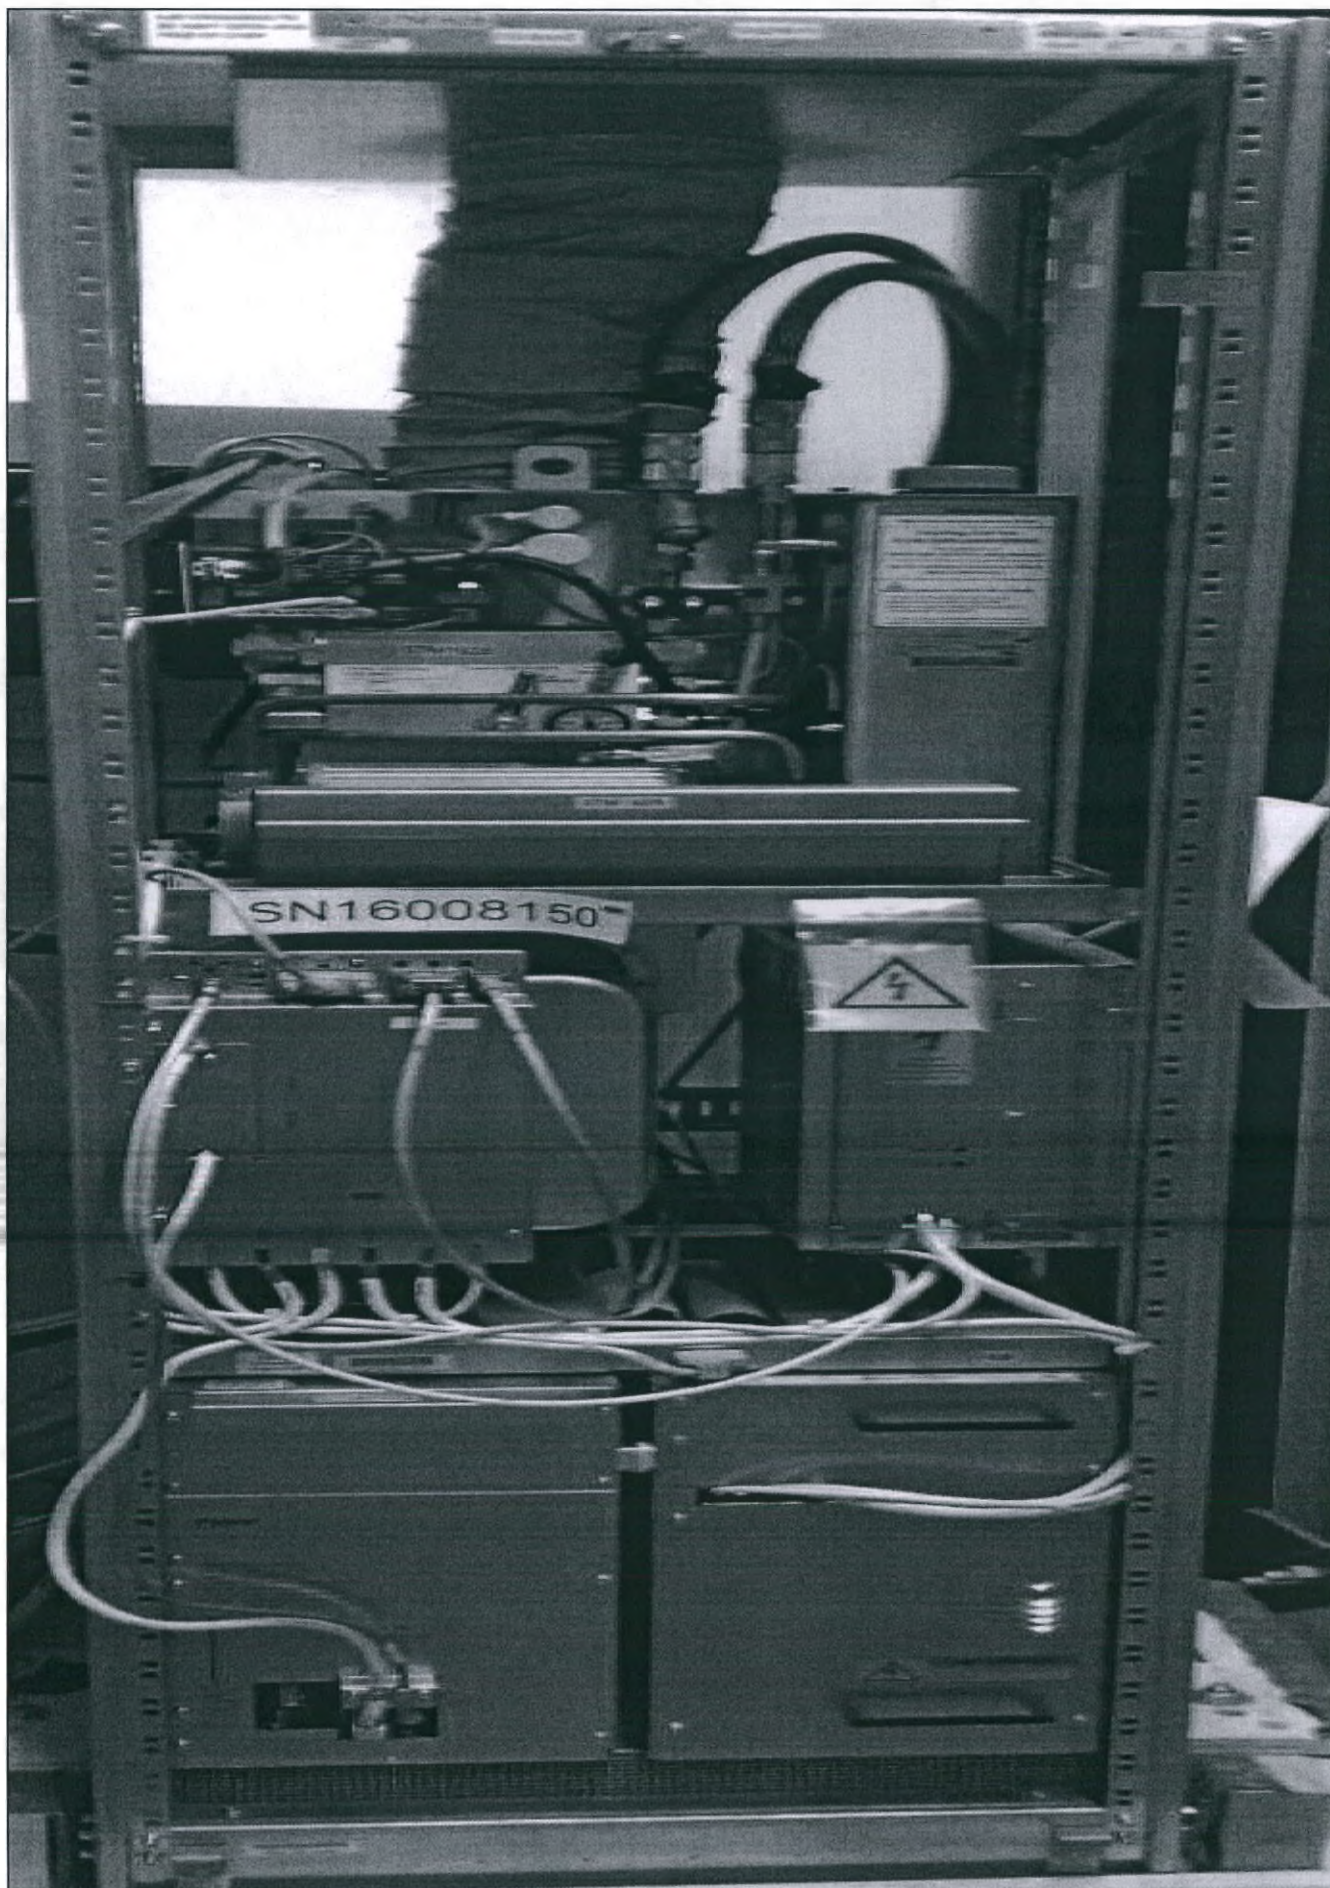



4.б. Распределительный шкаф с генератором рентгеновского излучения.

5.а. Шкаф управления.

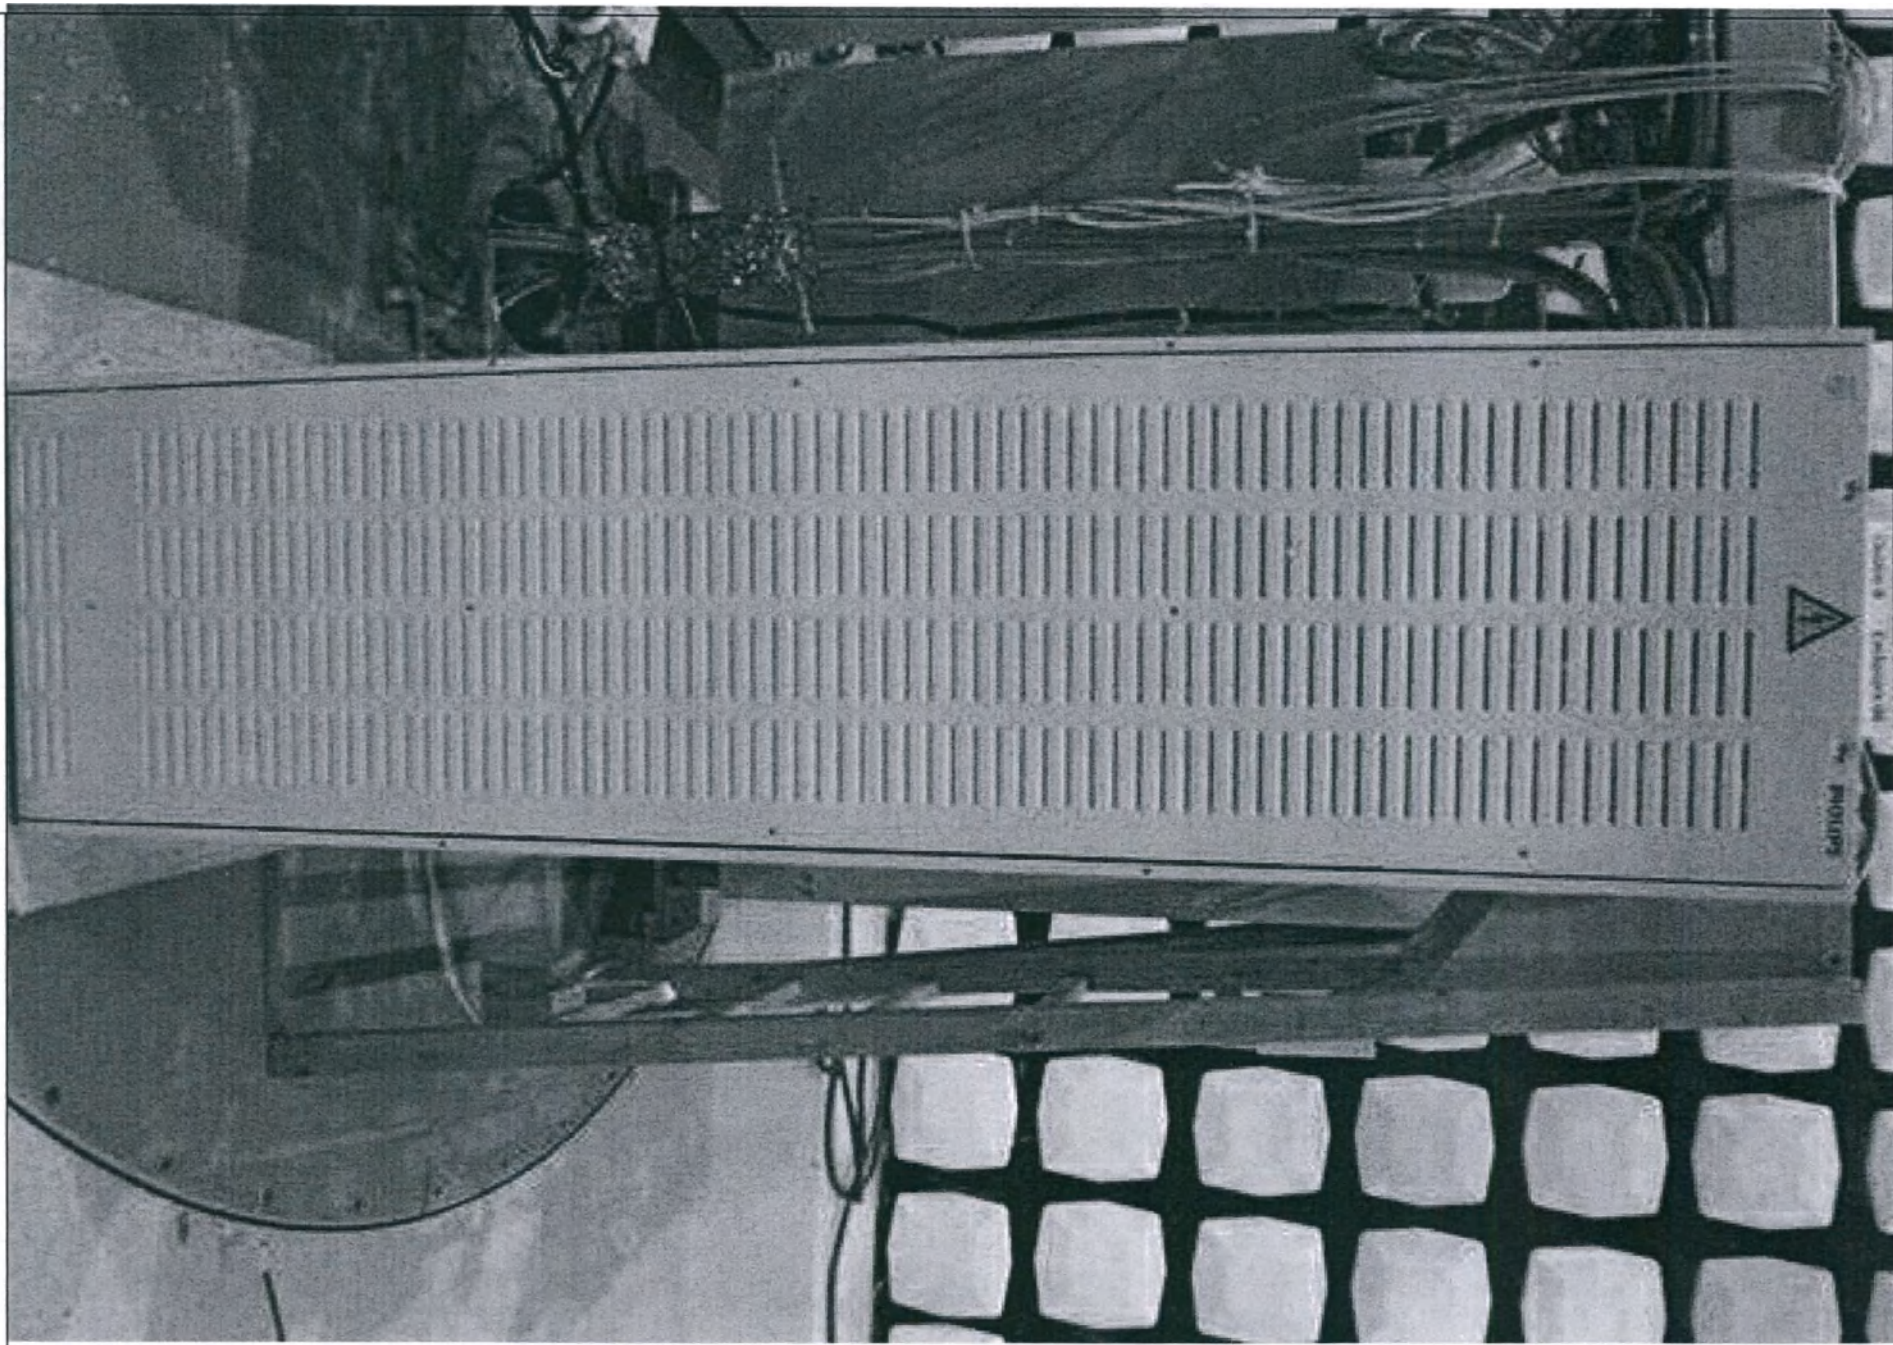


5.6. Шкаф управления.

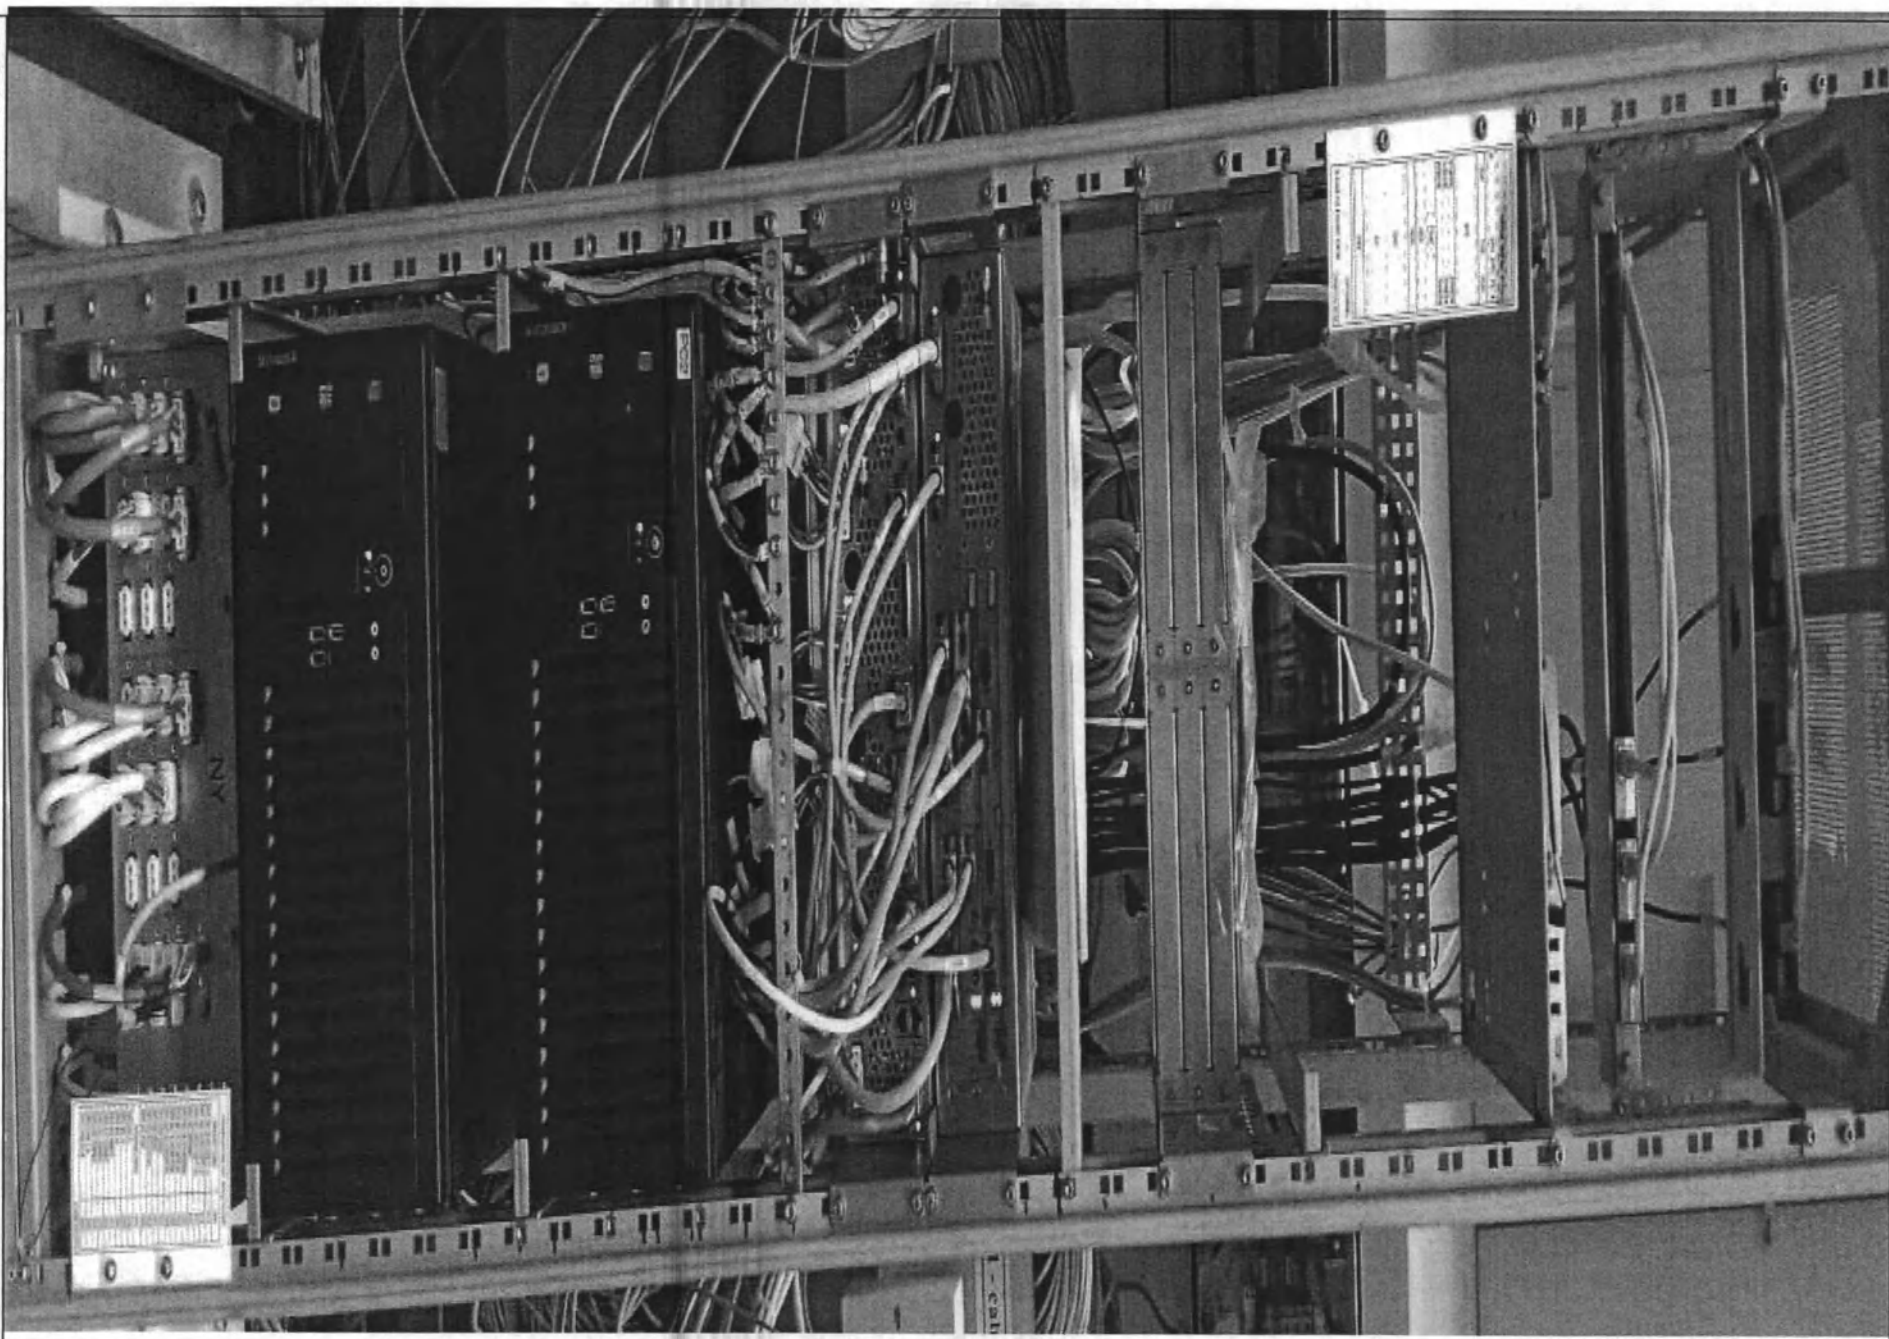


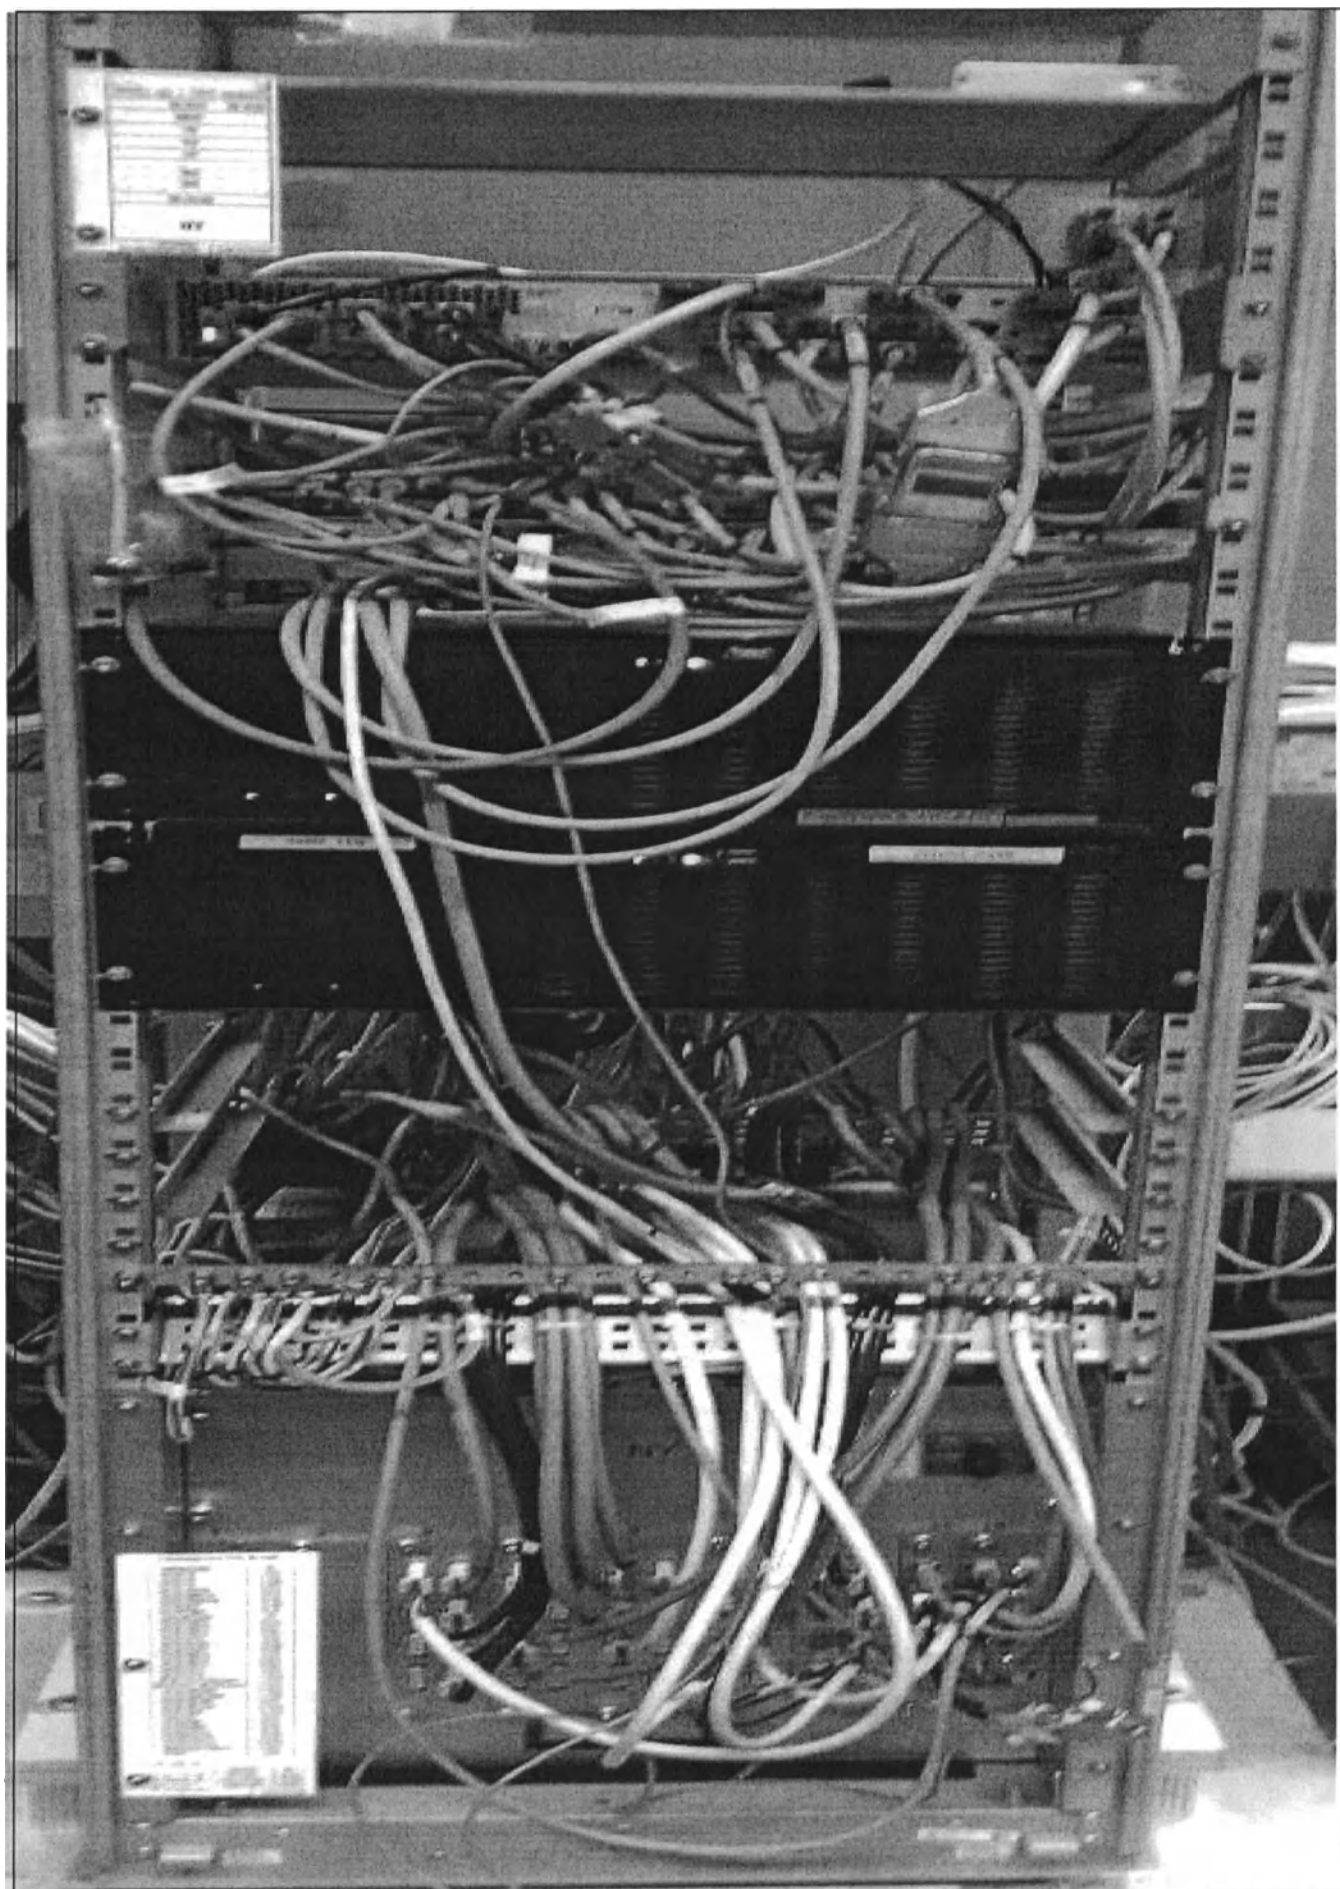


6.а. Распределительный щит.

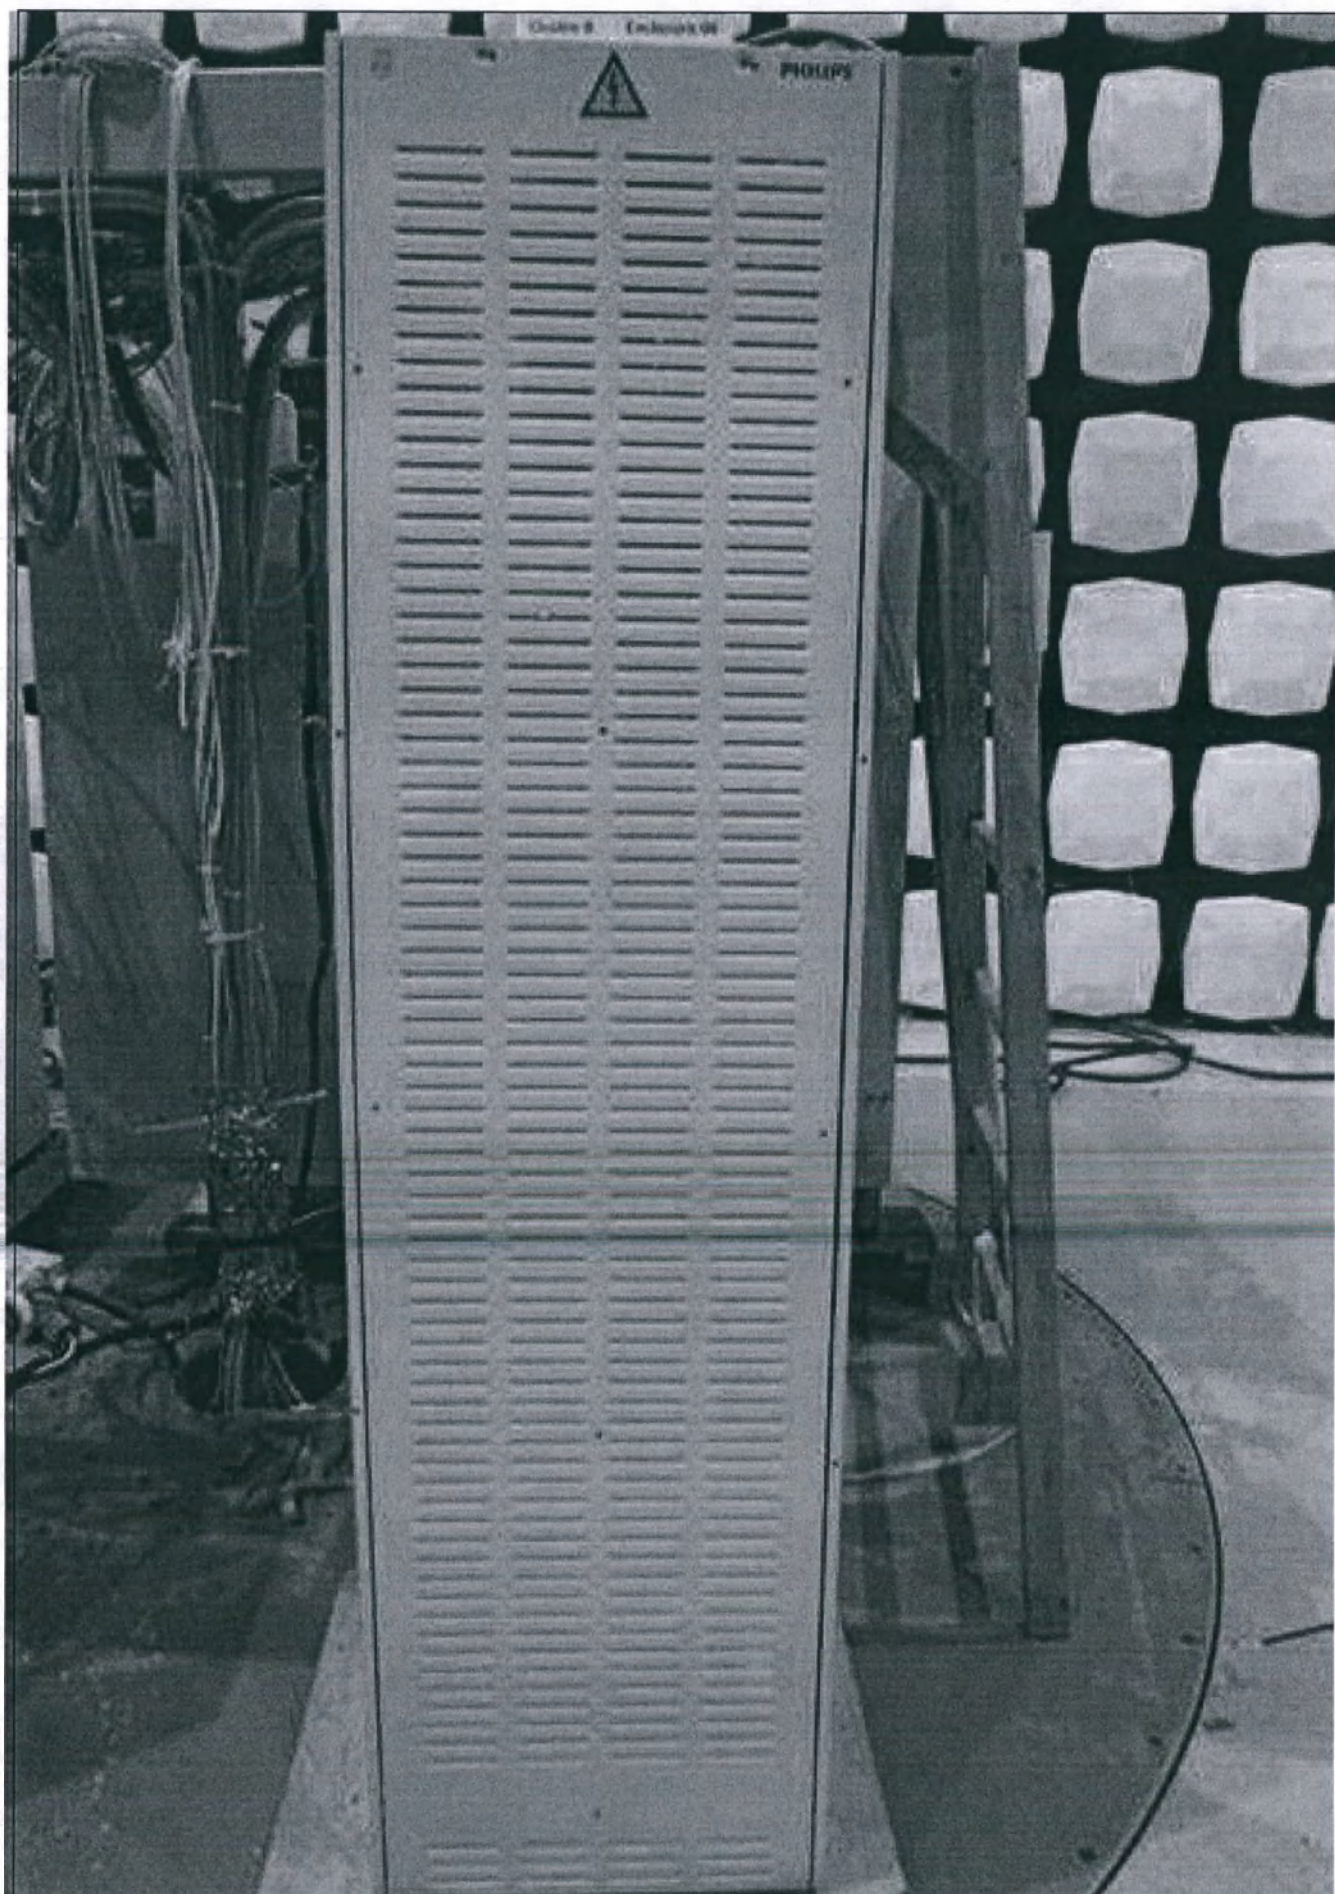


6.6. Распределительный щит.

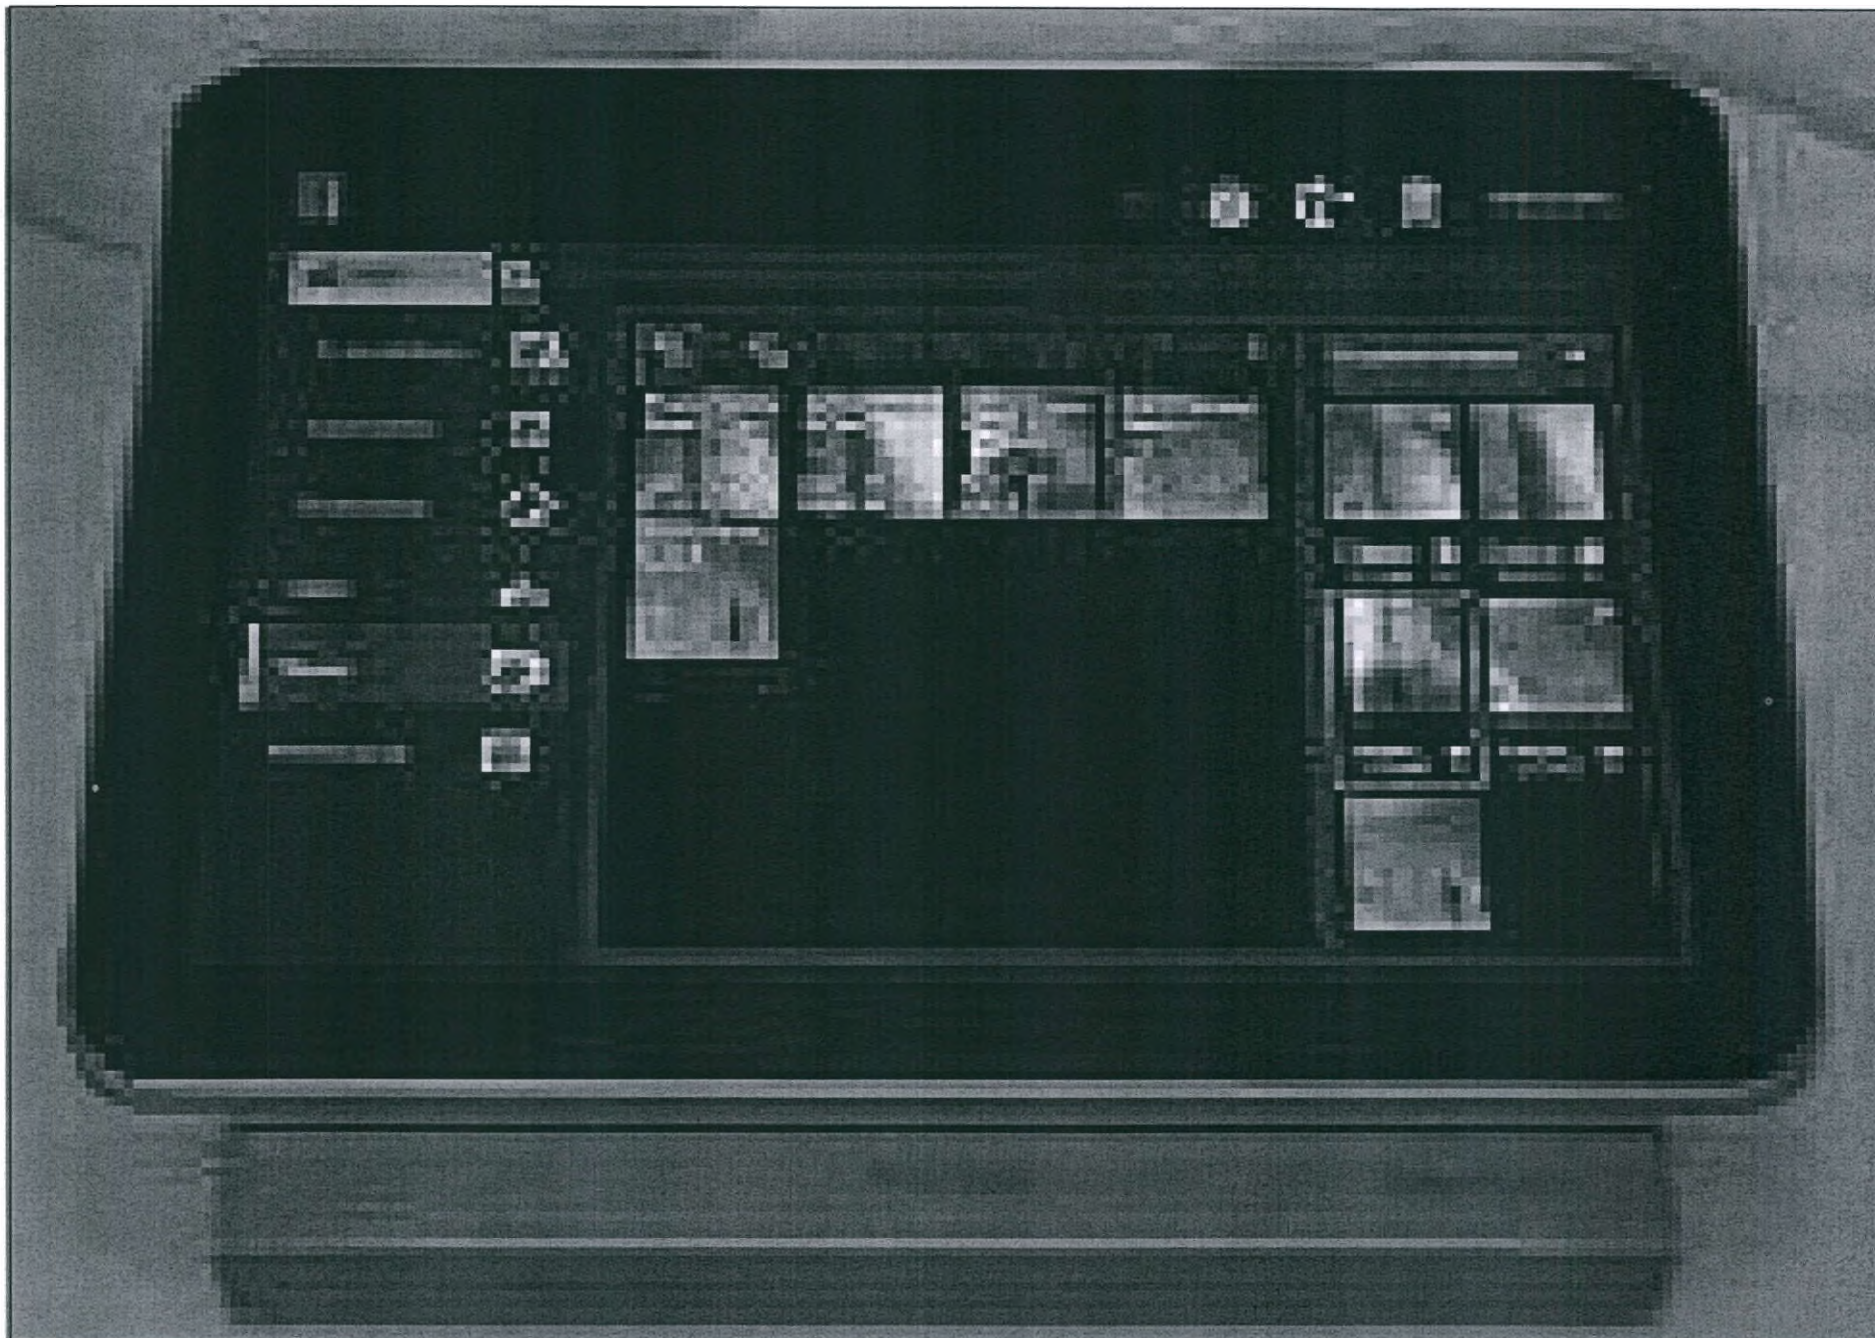


7. Модуль сенсорного экрана, не более 4 шт.

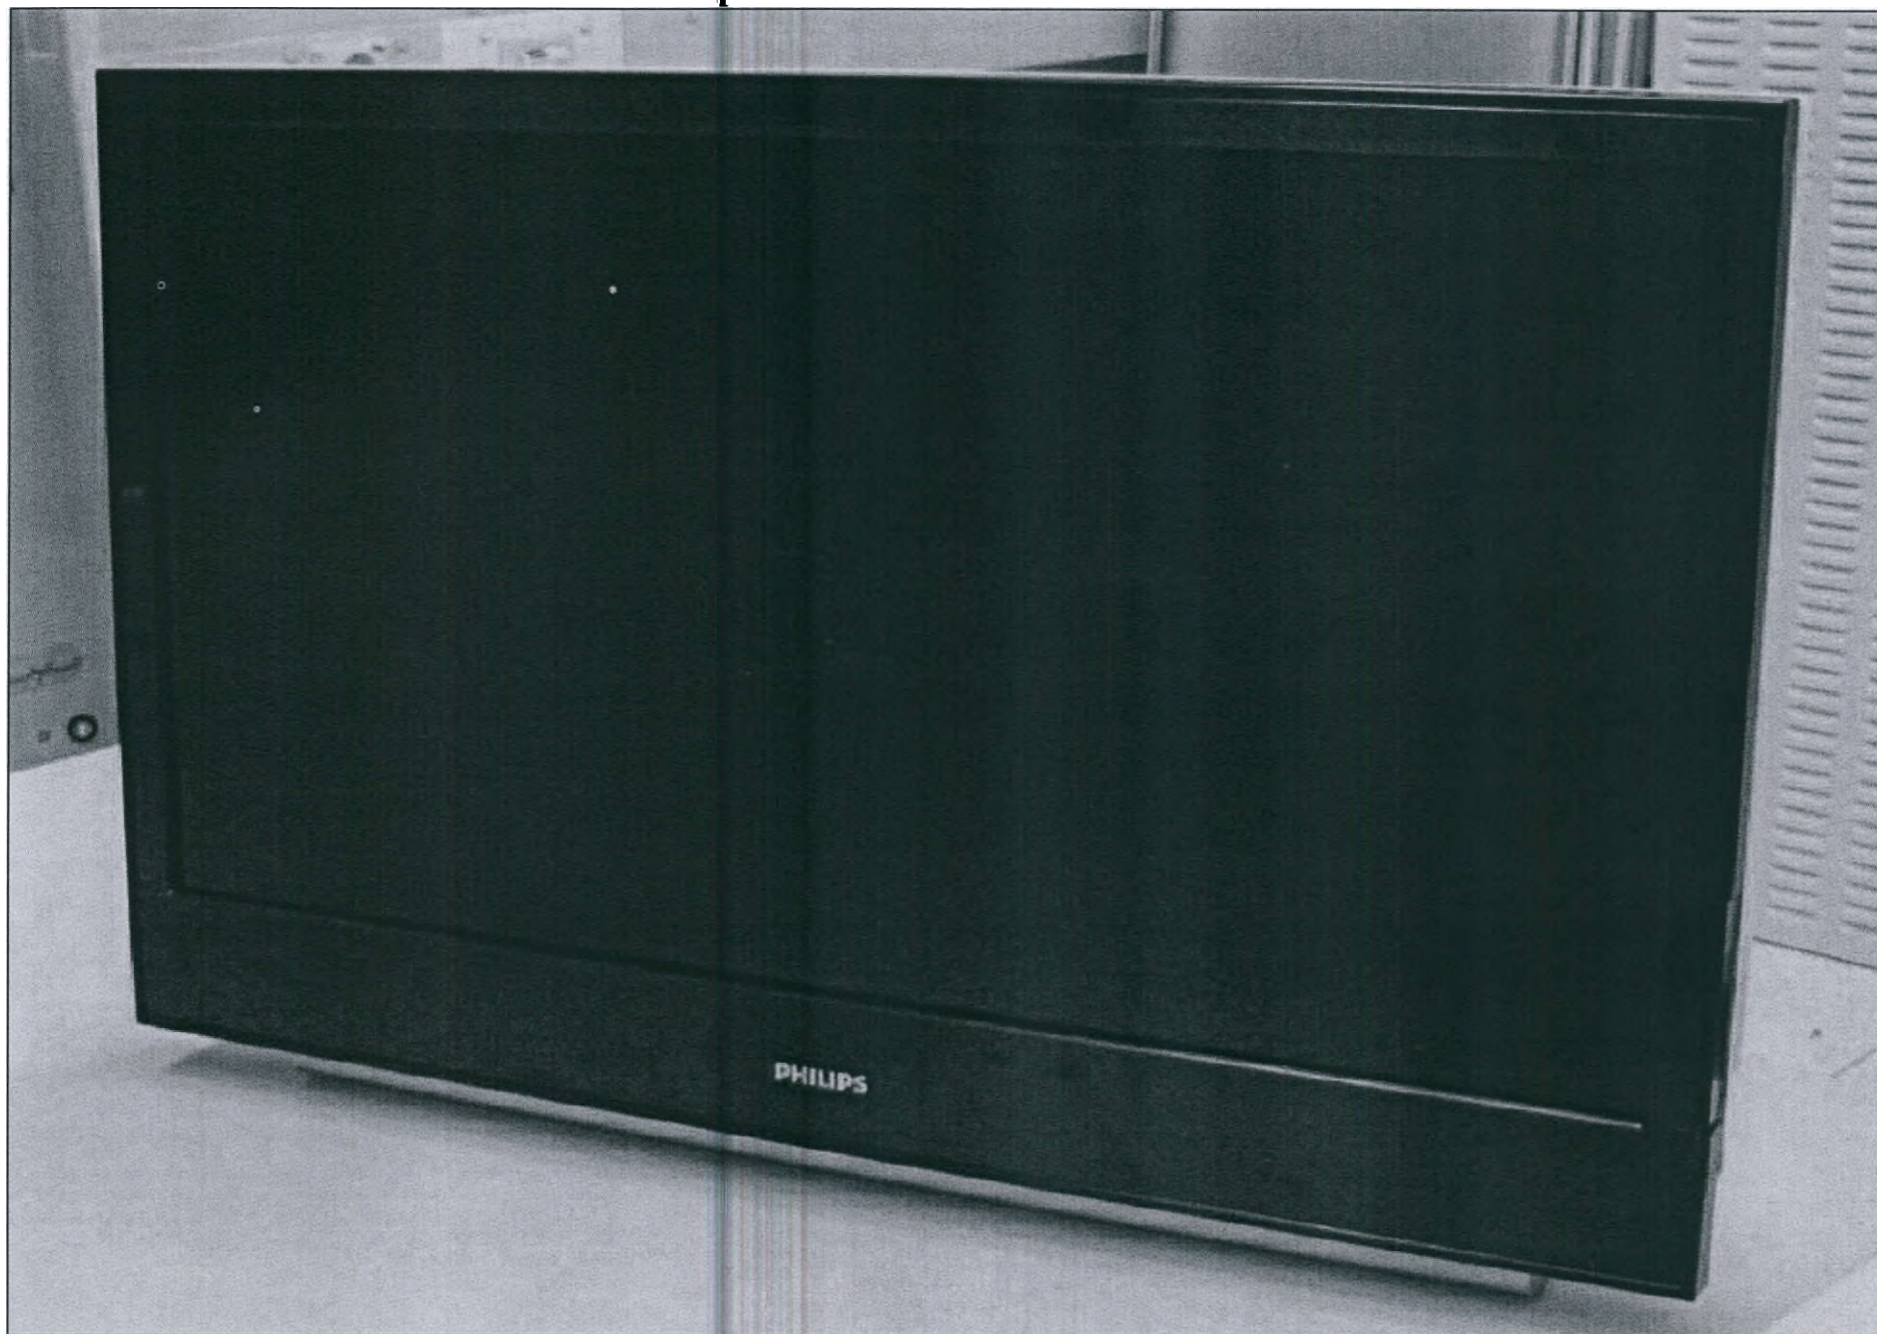

8. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов

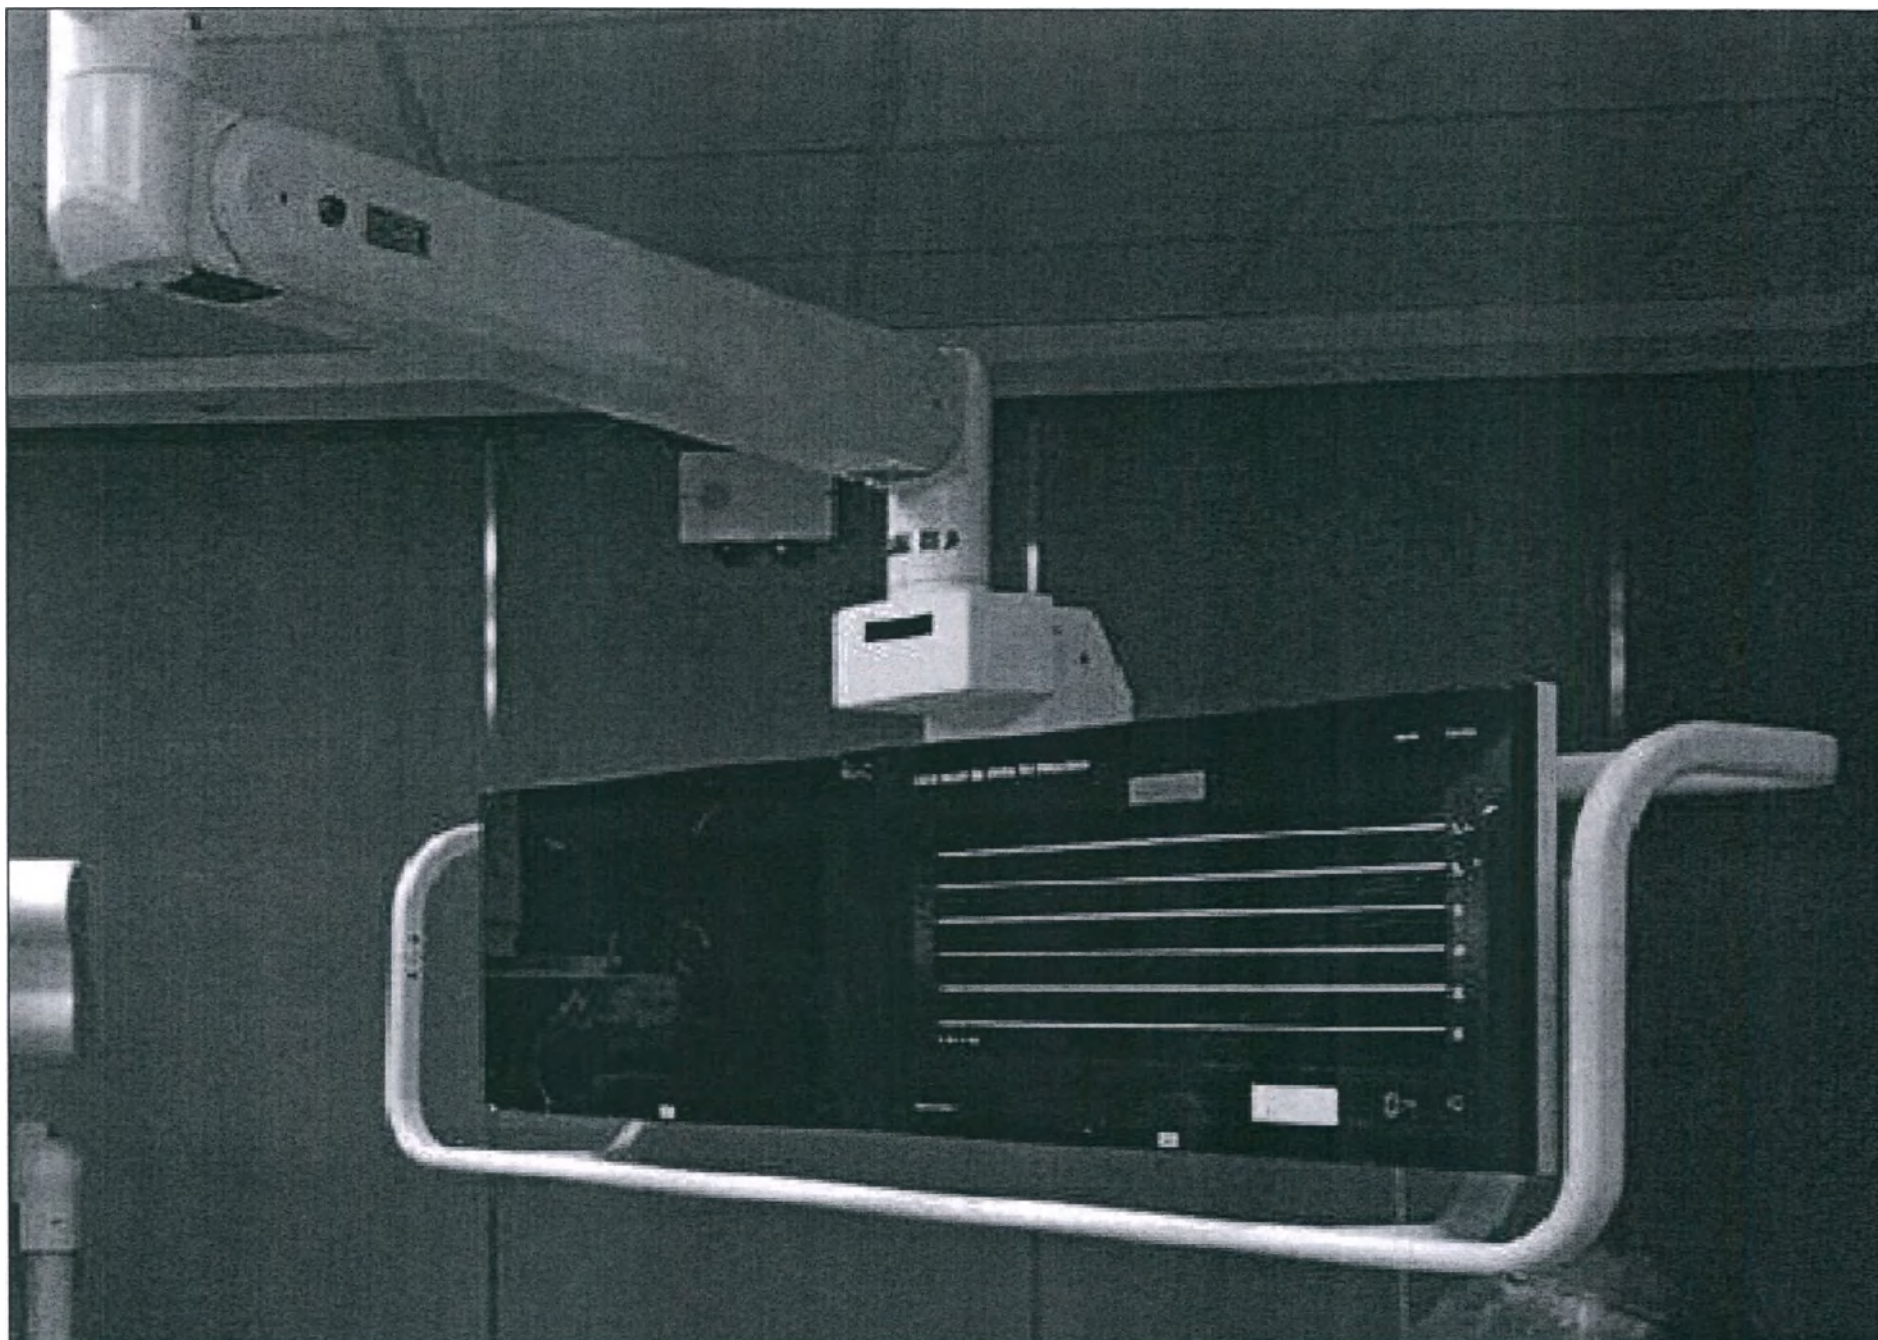


9. Потолочный подвес для мониторов 2-секционный

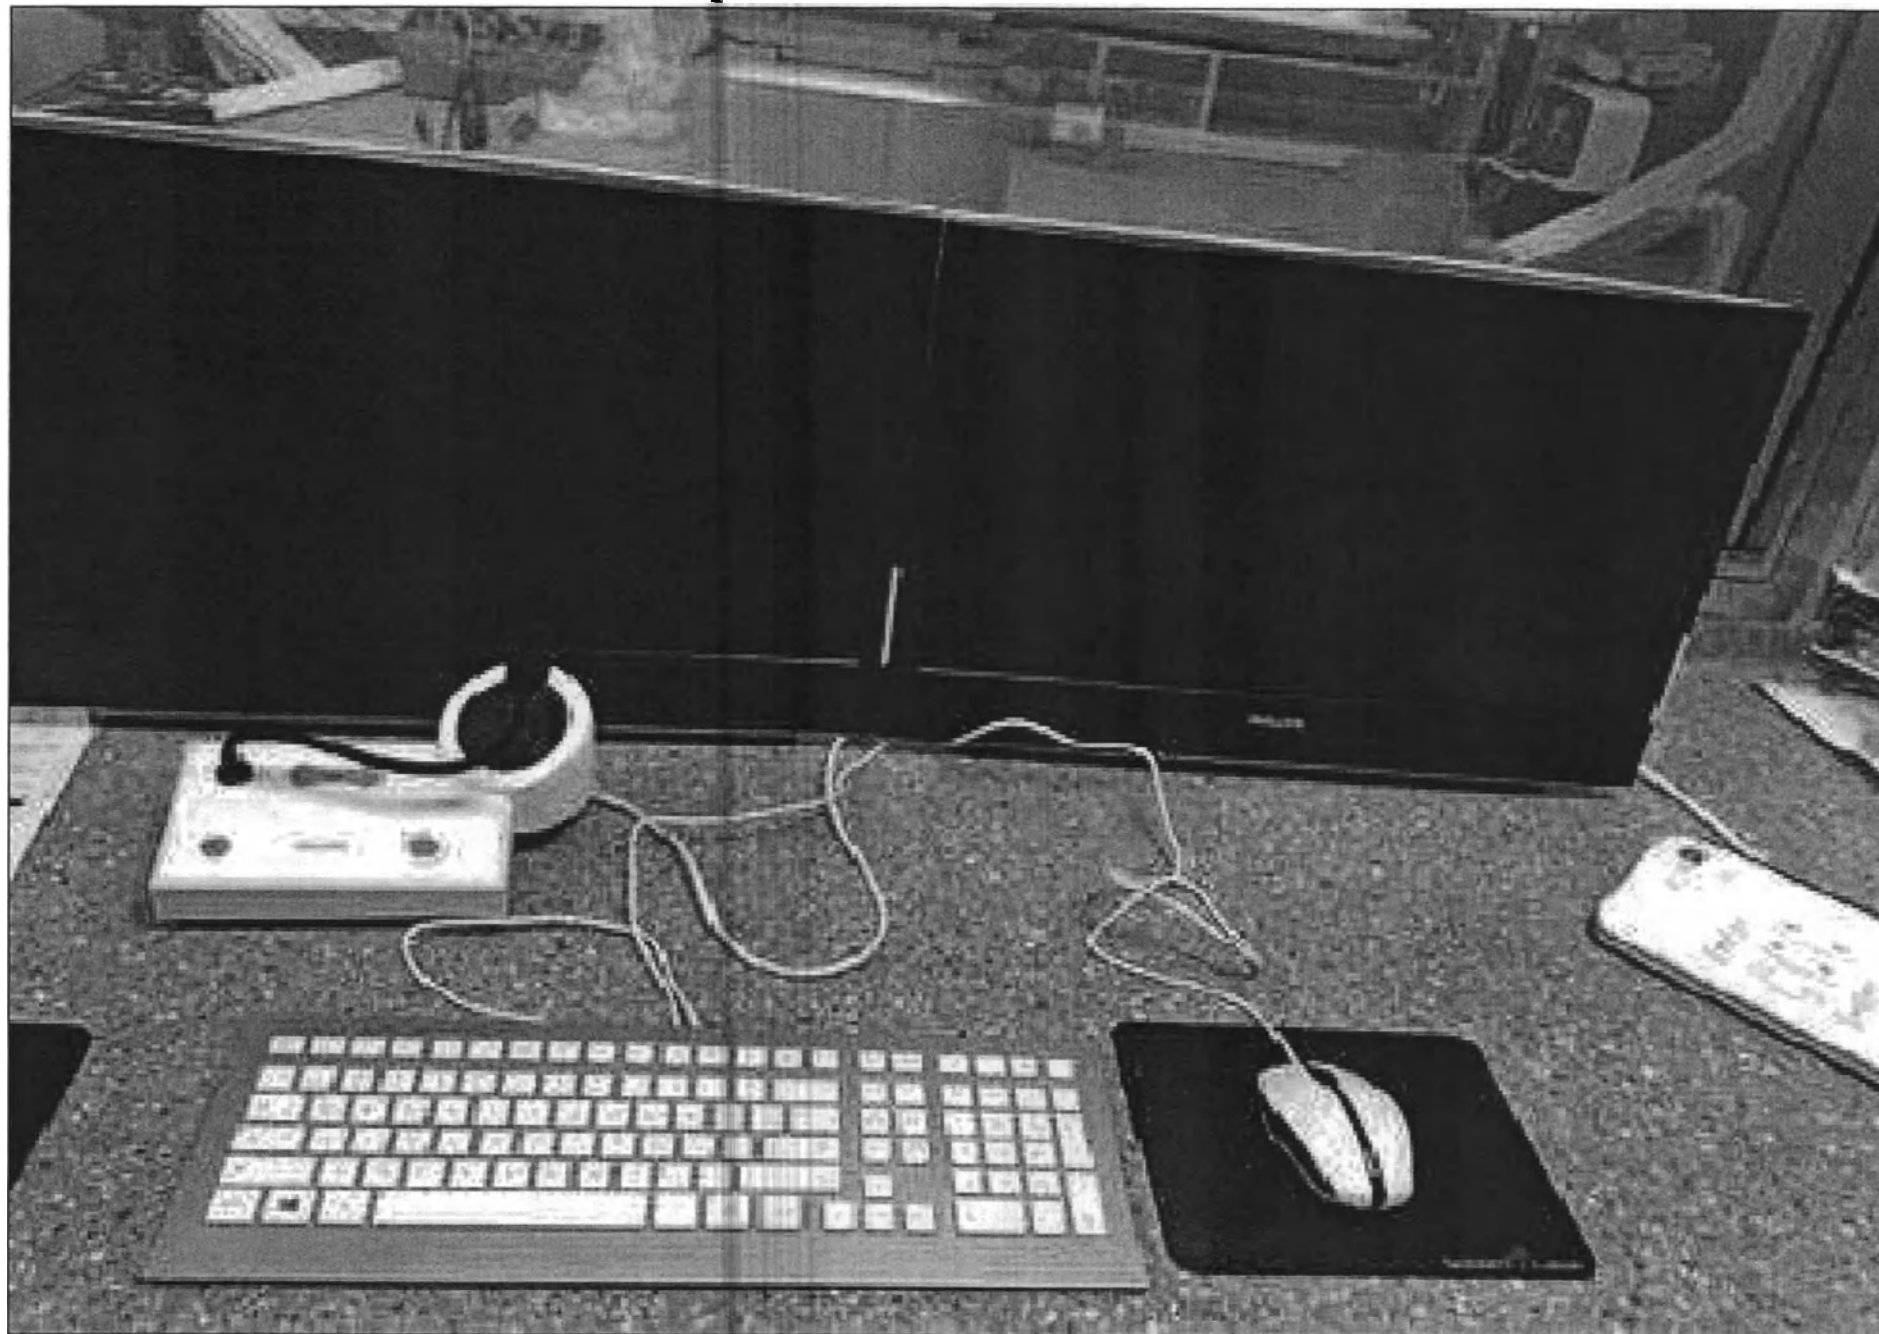


10.а. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.



10.6. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

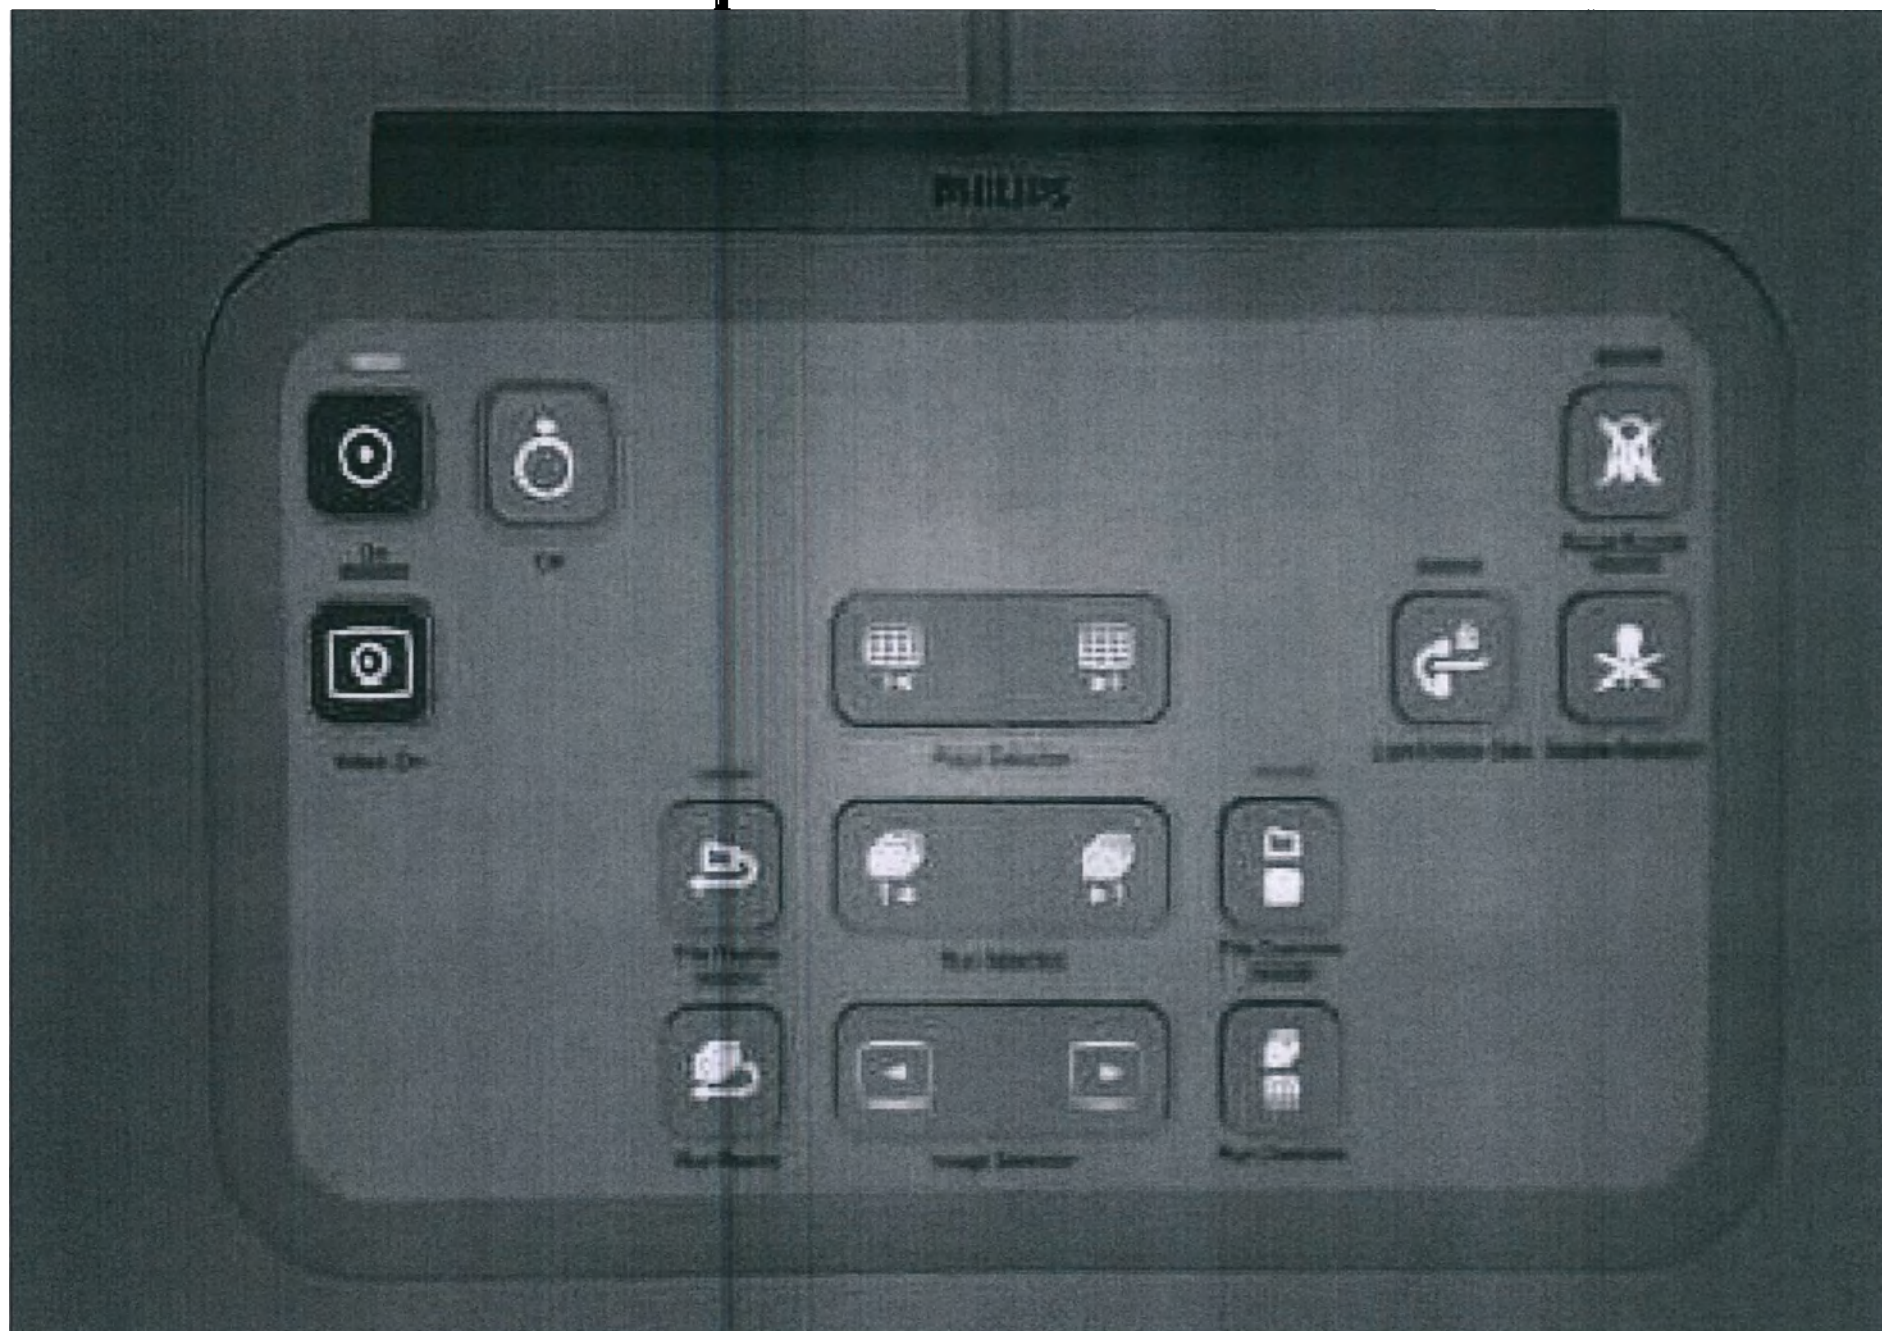


10.в. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

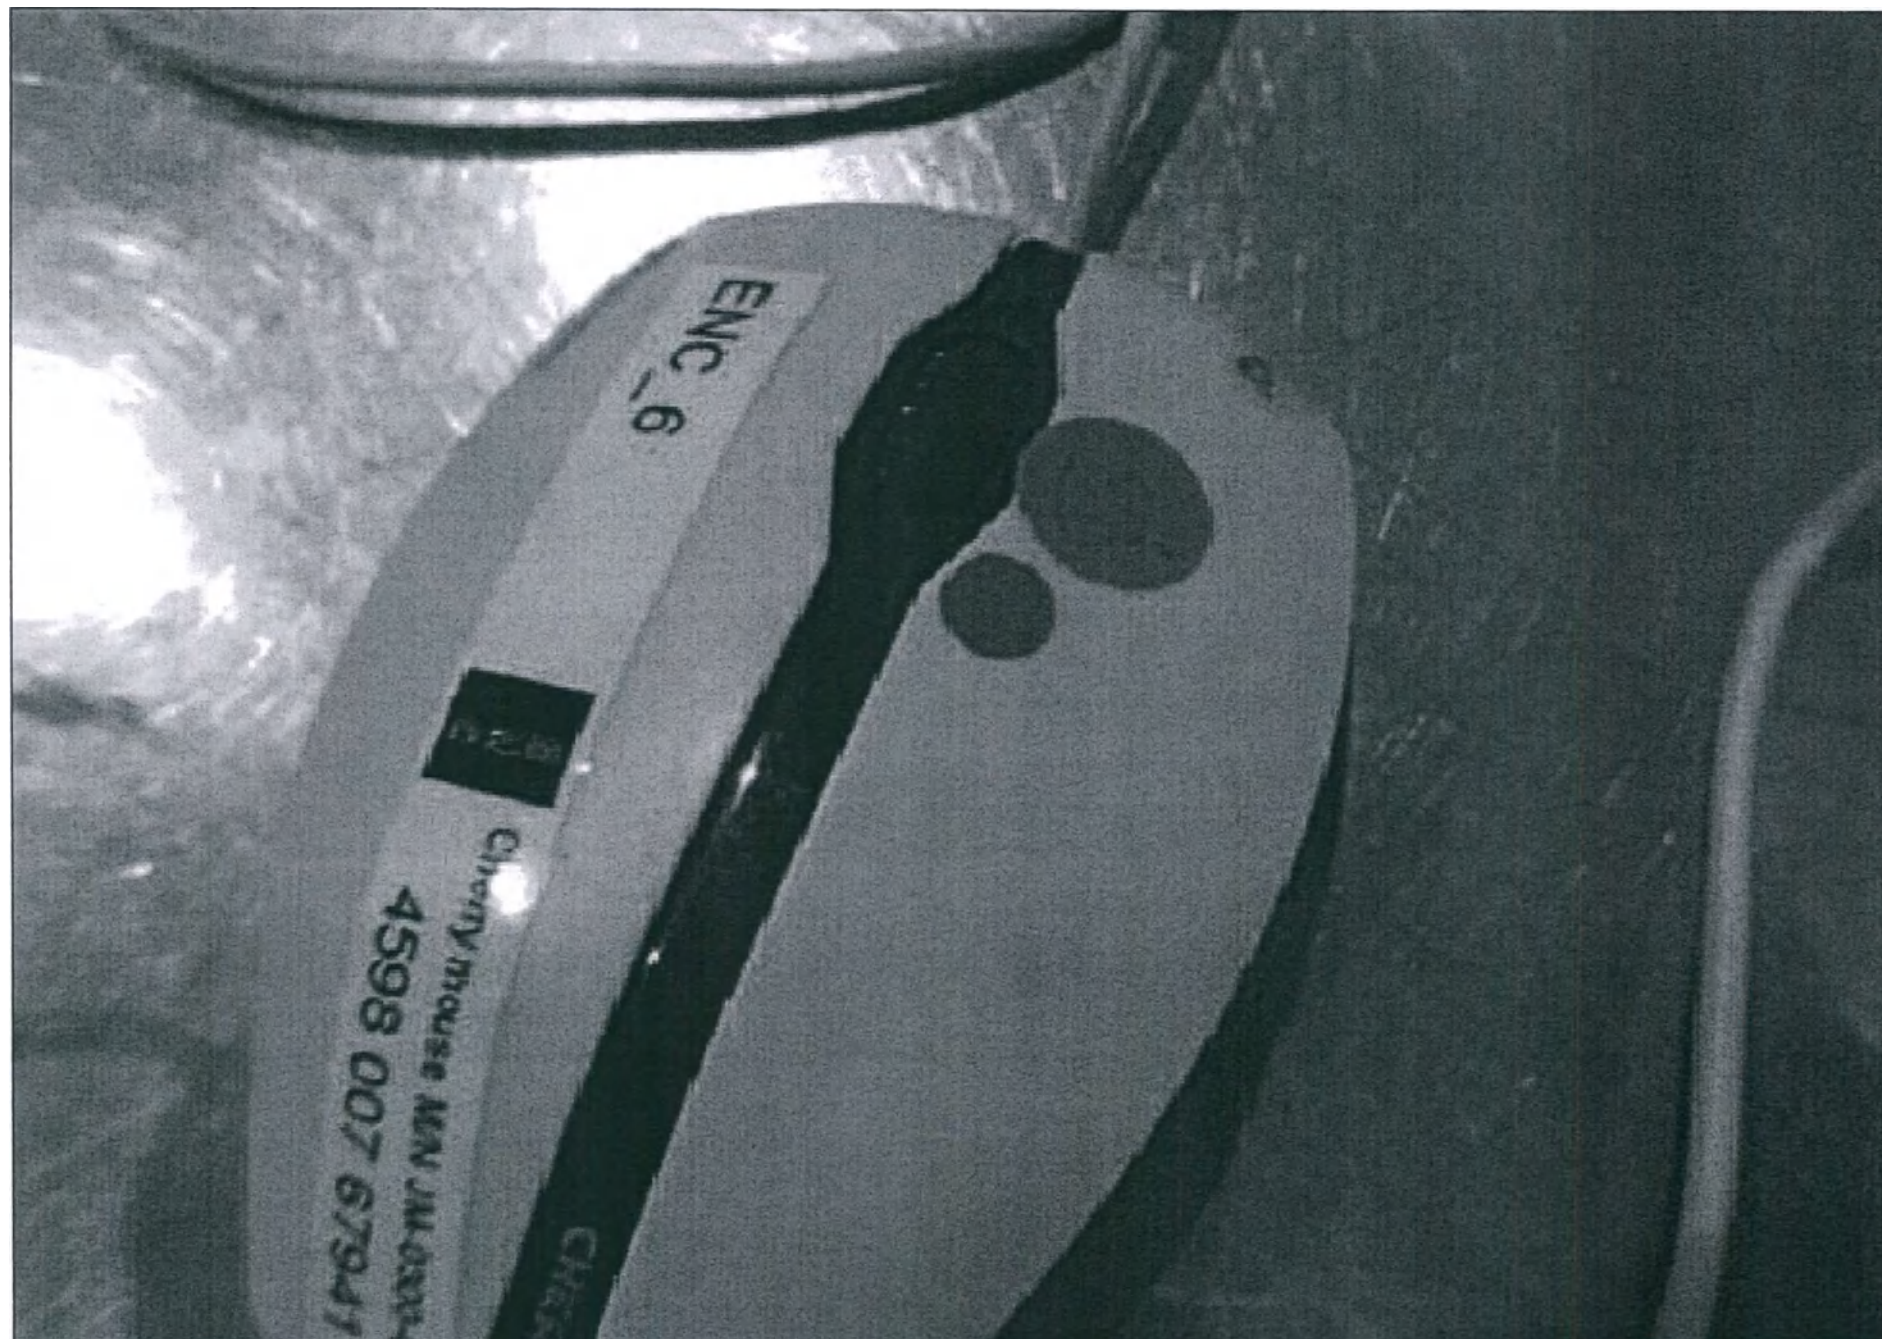

10.2. Оборудование пультовой в составе: Мониторы цветные для пультовой диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.




10.д. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

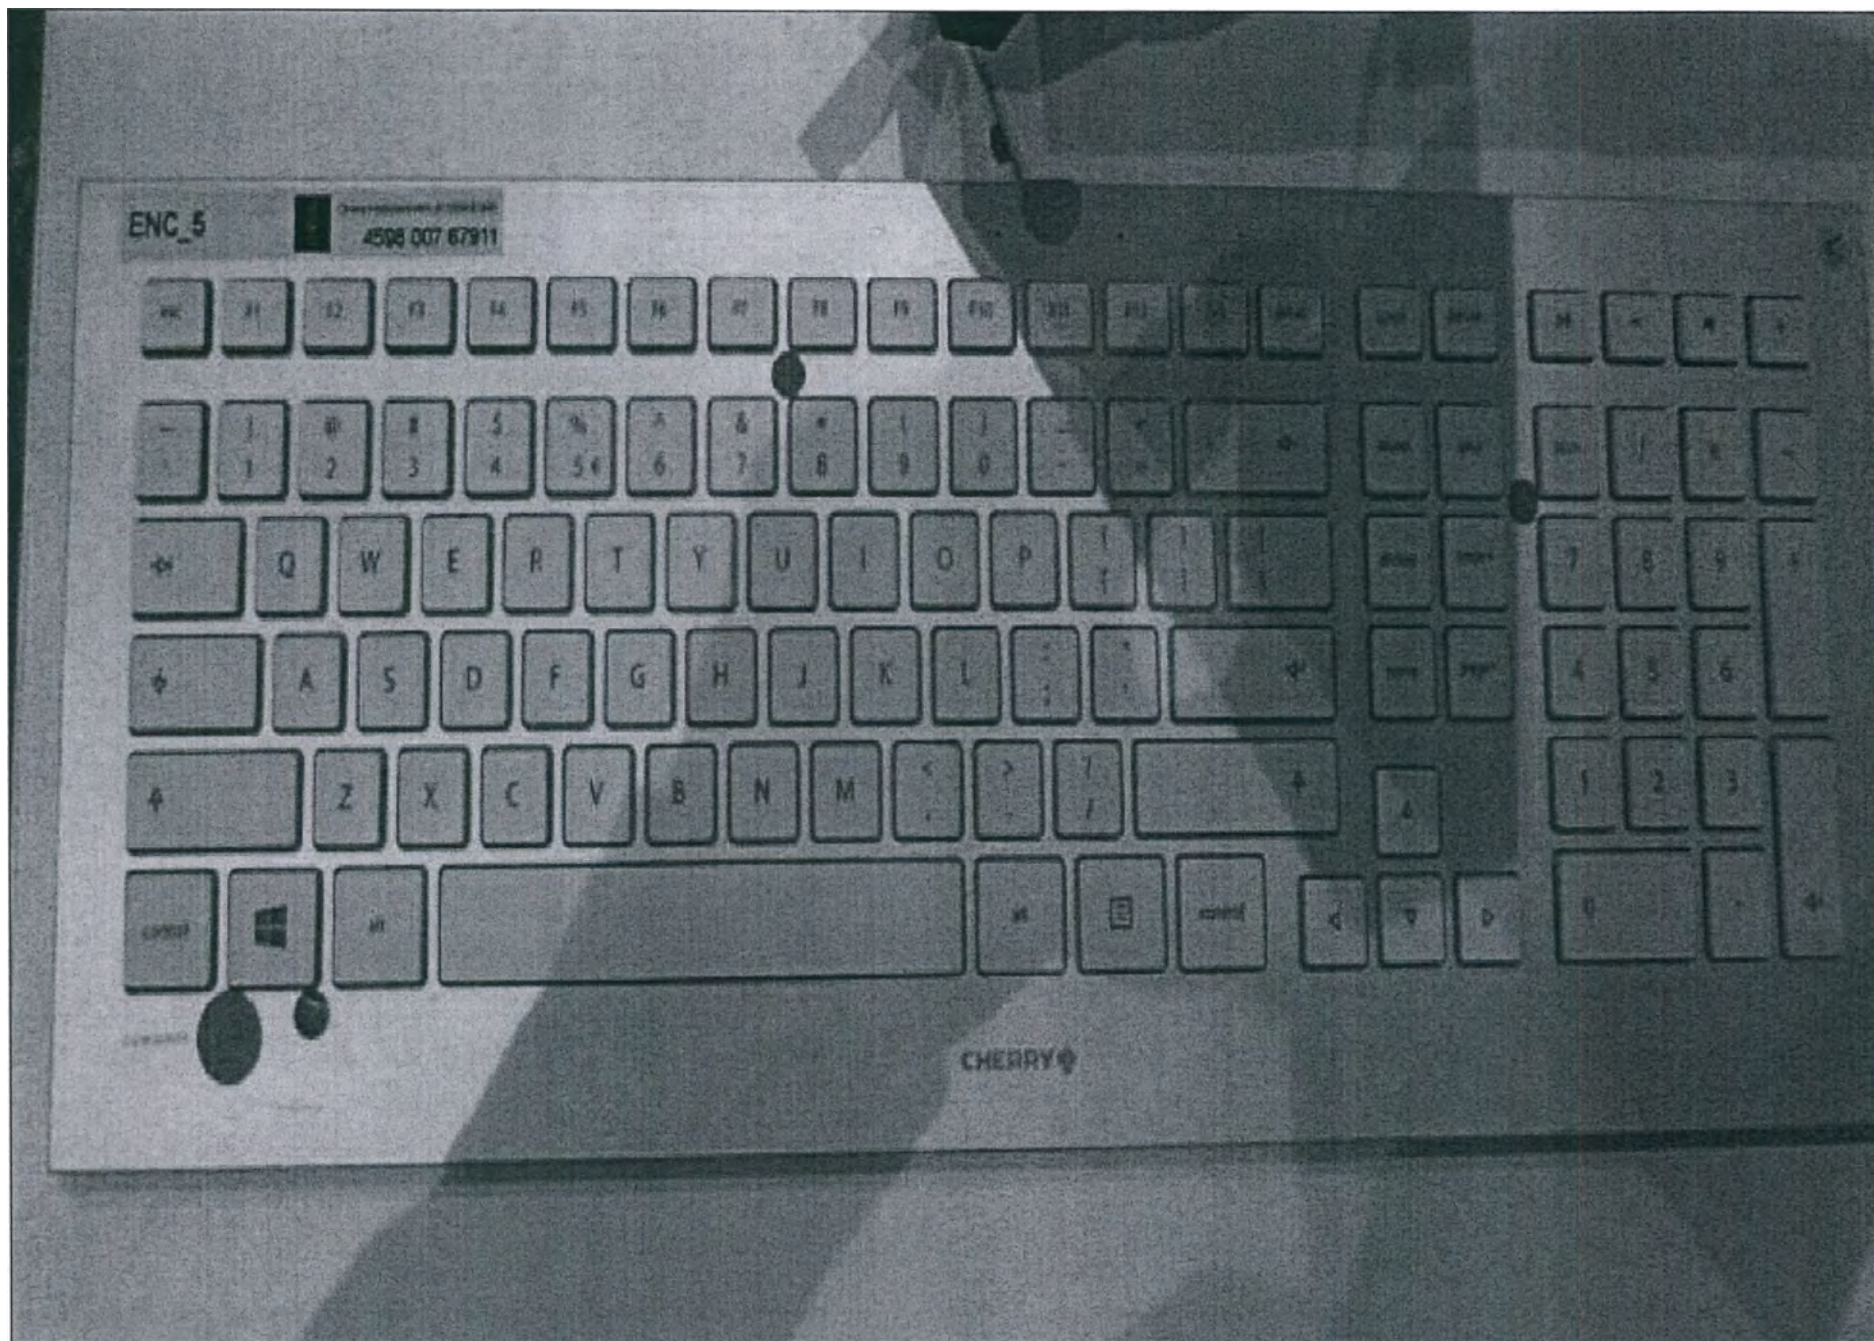


10.е. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.



10.ж. Оборудование пультной в составе: Мониторы цветные для пультной диагональю 24 дюйма; Модуль просмотра; Мышь; Клавиатура; Системный блок с базовым программным обеспечением для системы Azurion версия 2.1 и выше.

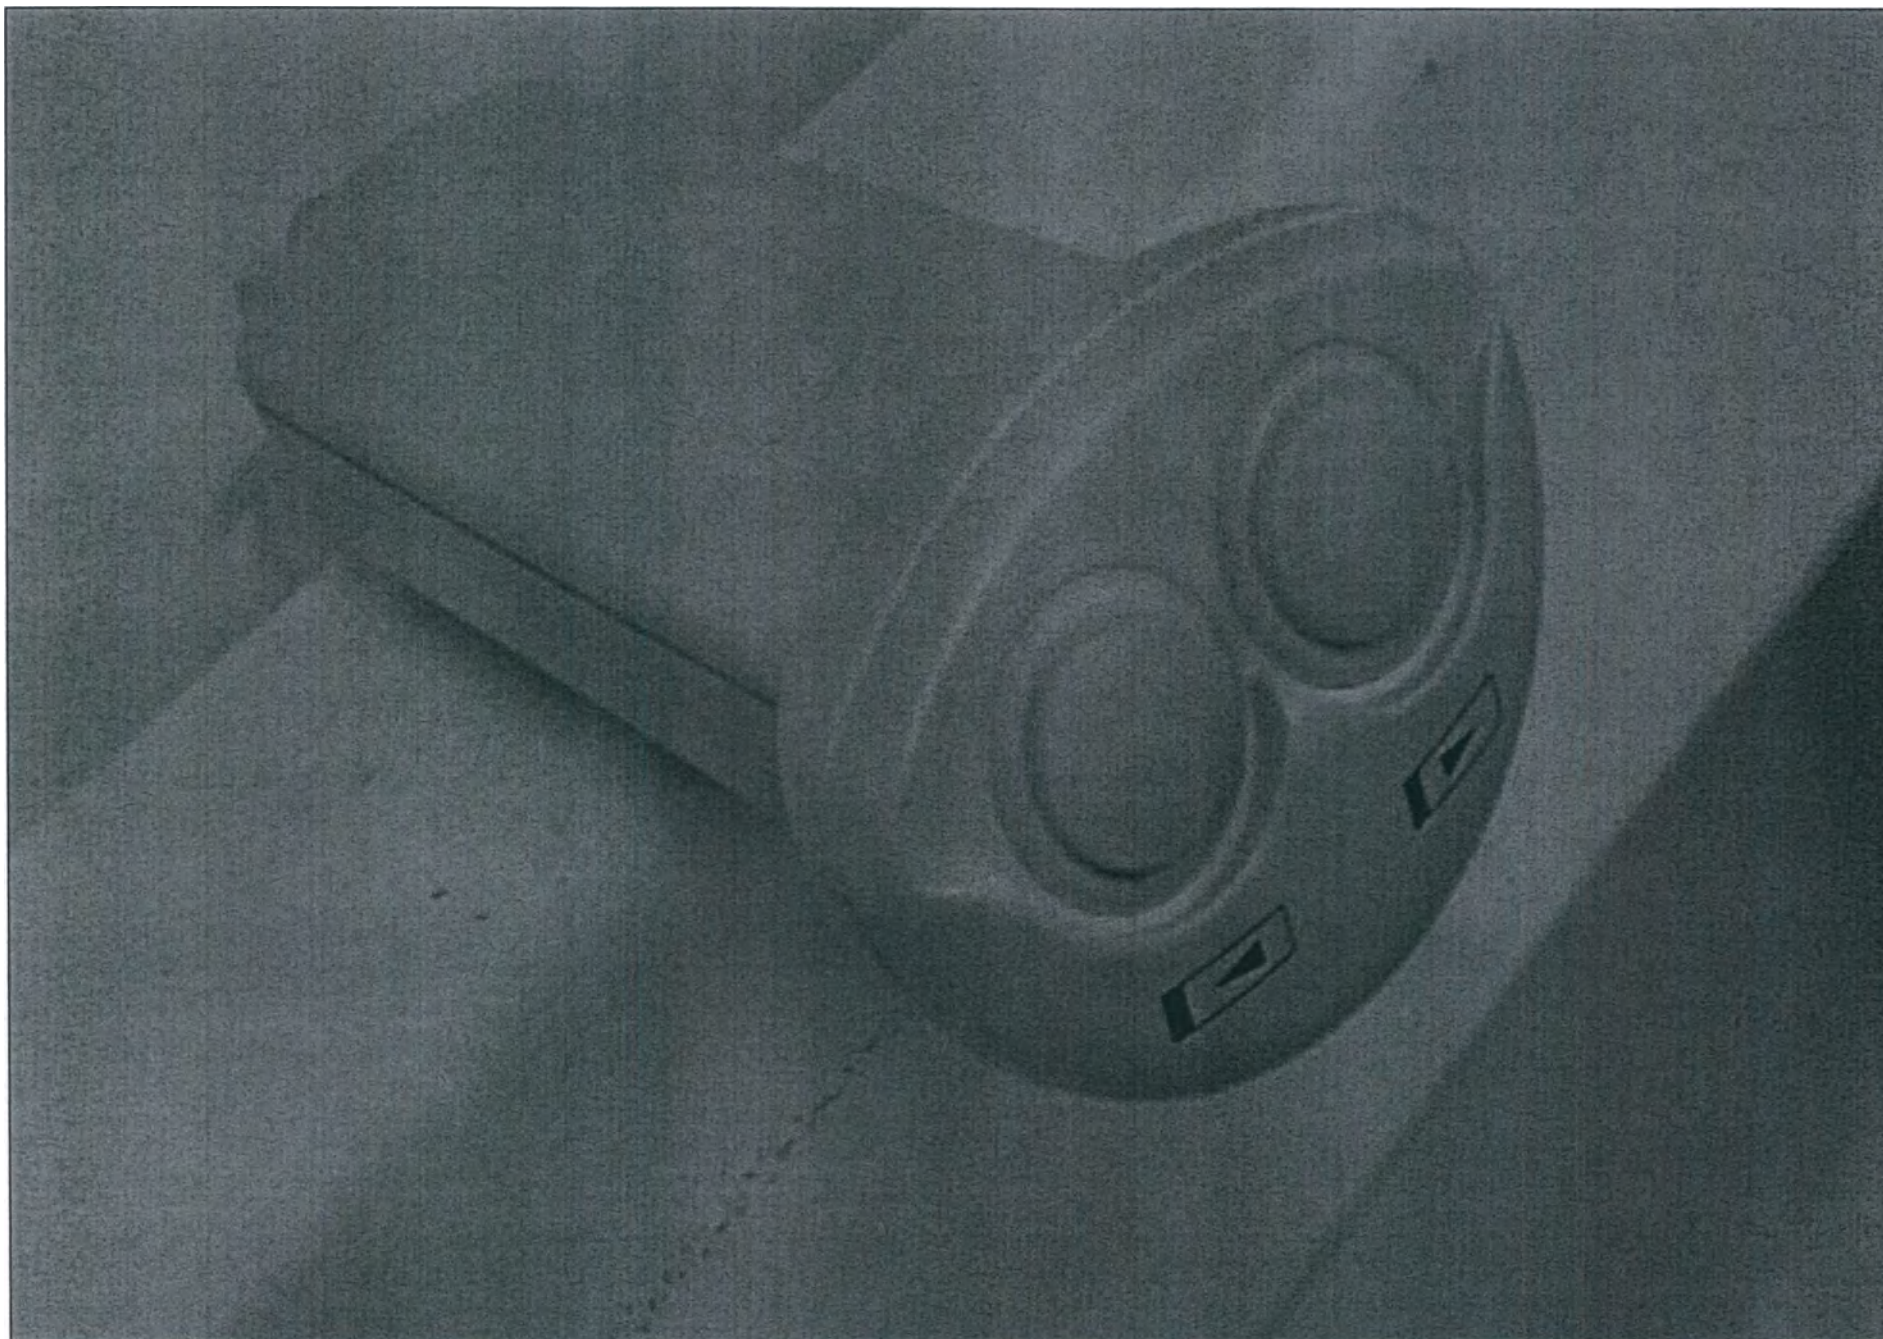


11. Ручной переключатель сдвига.

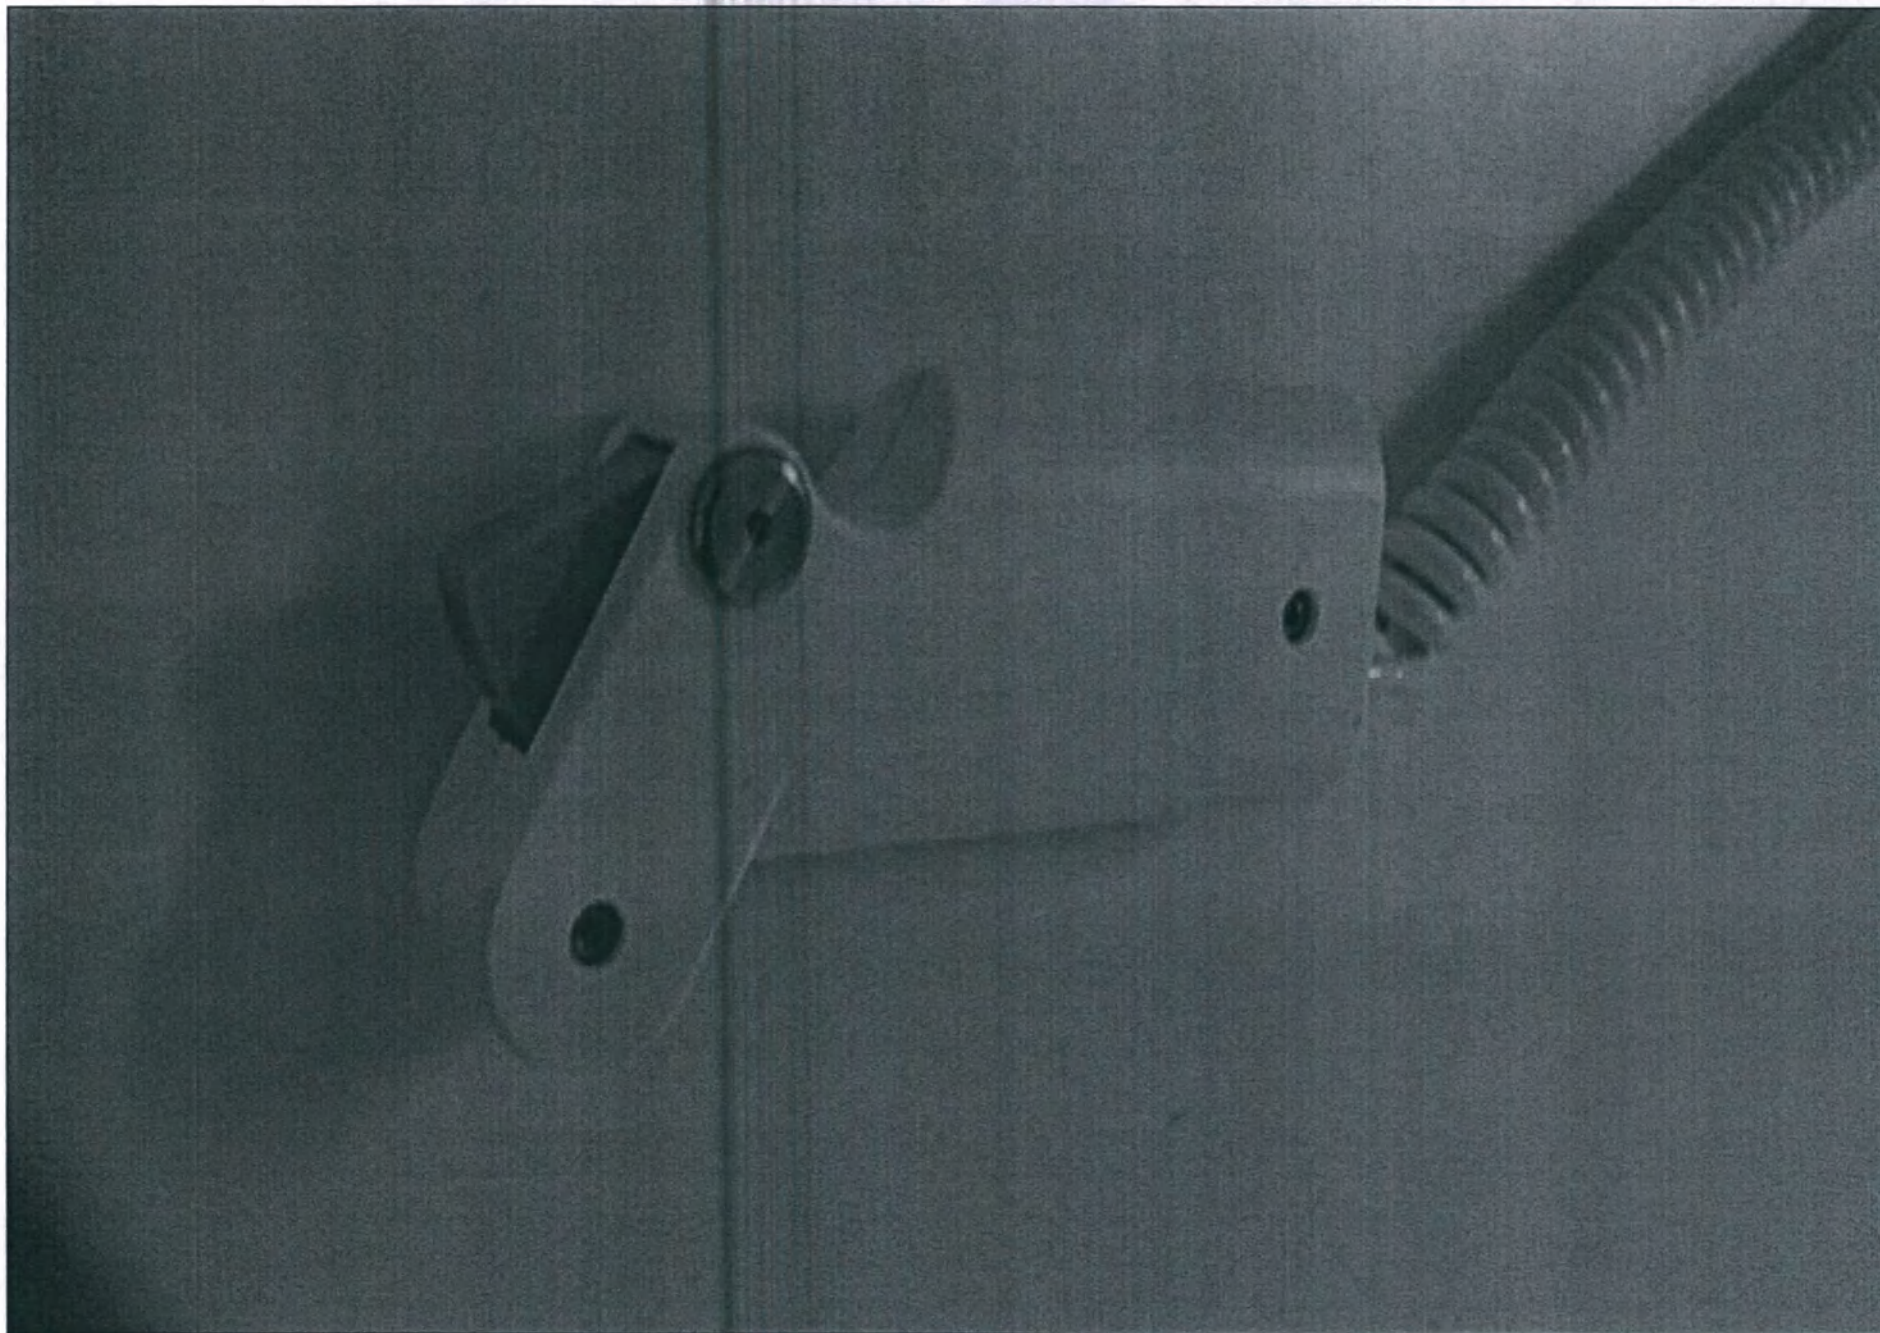


12. Регулятор скорости.




13. Ручной переключатель экспозиции.

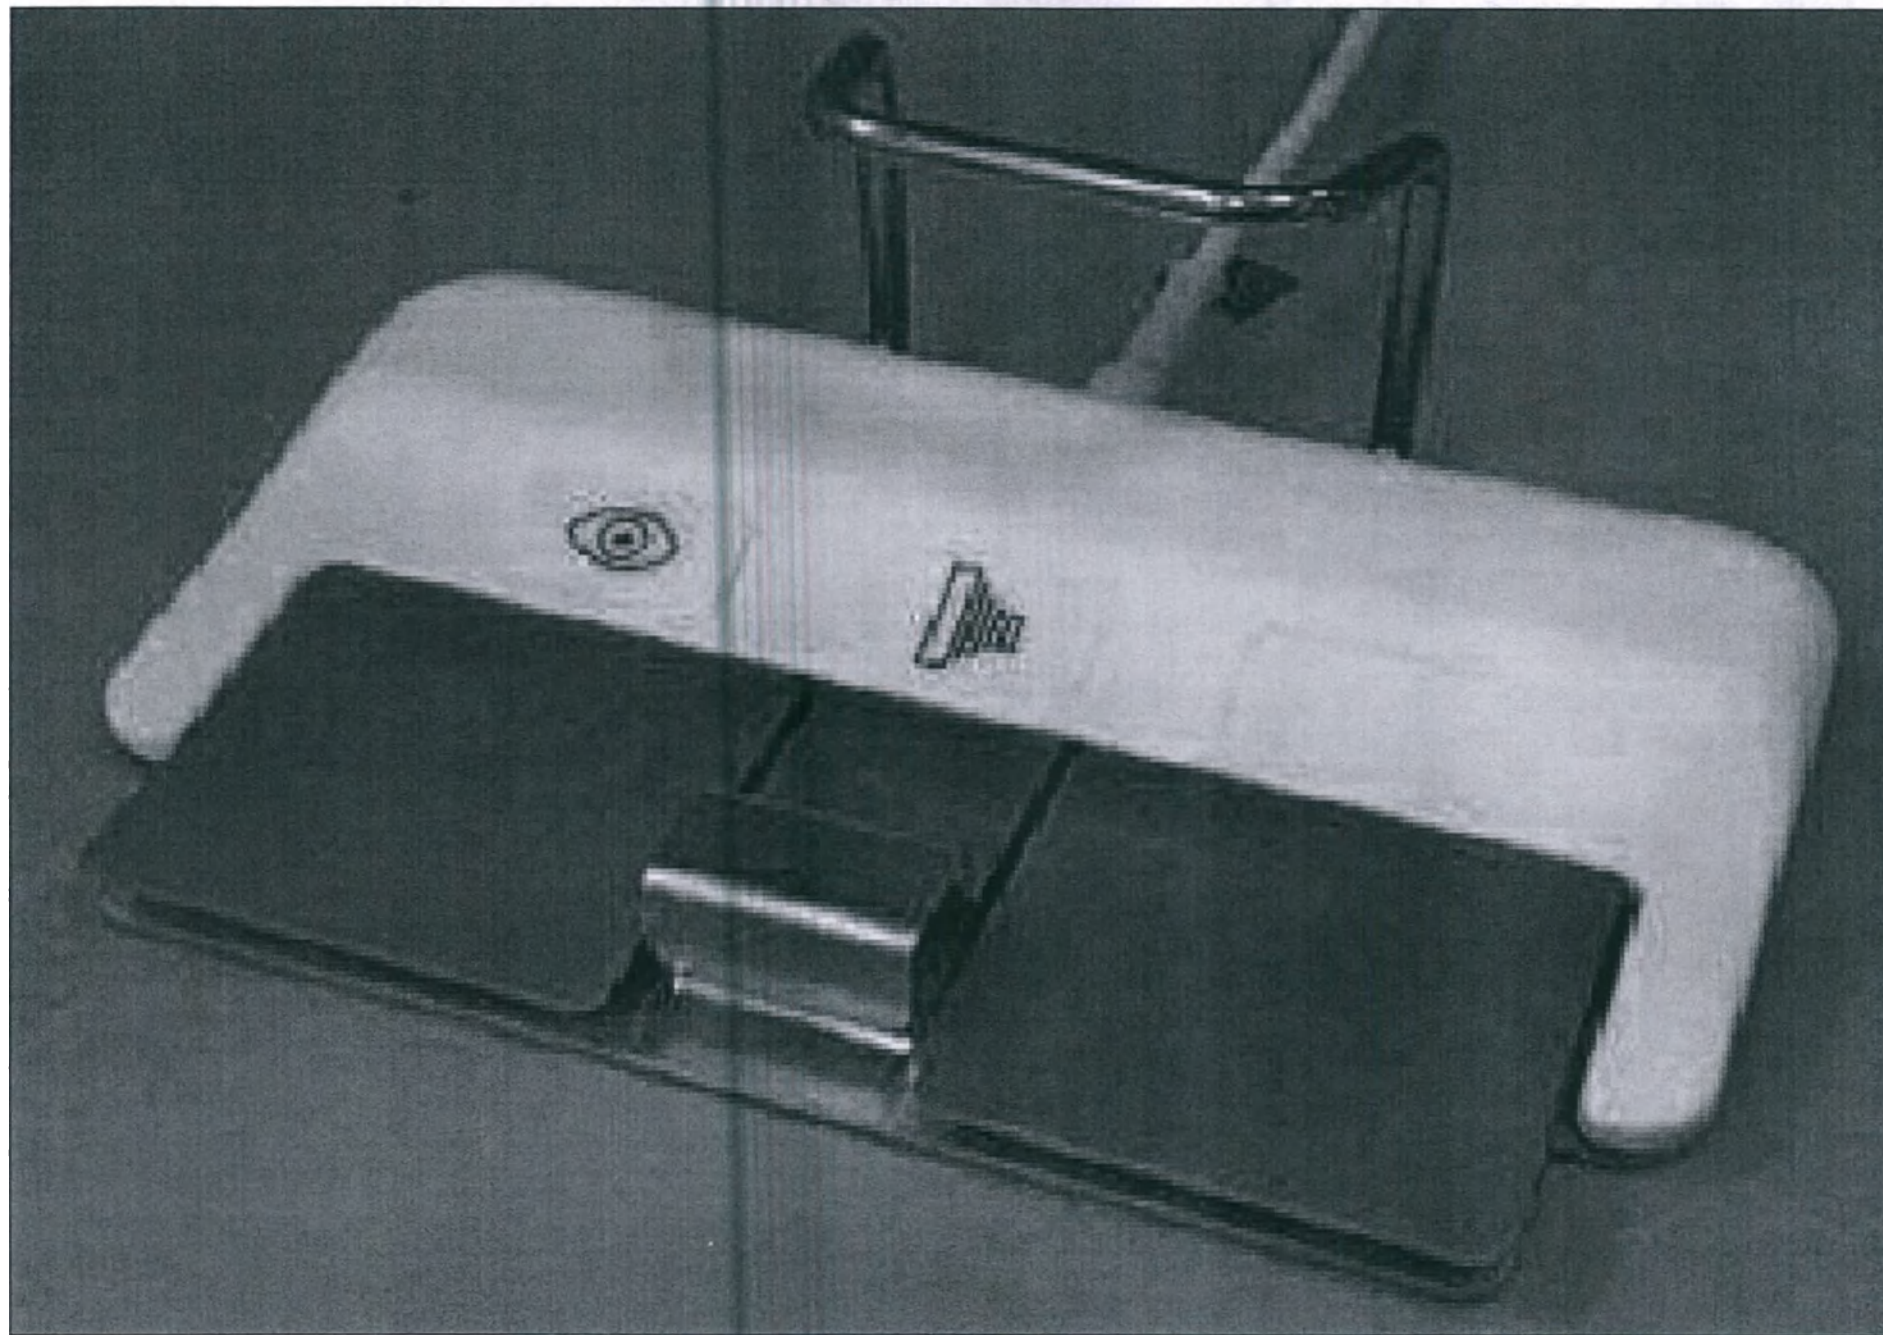


14. Ножной переключатель, не более 2 шт.

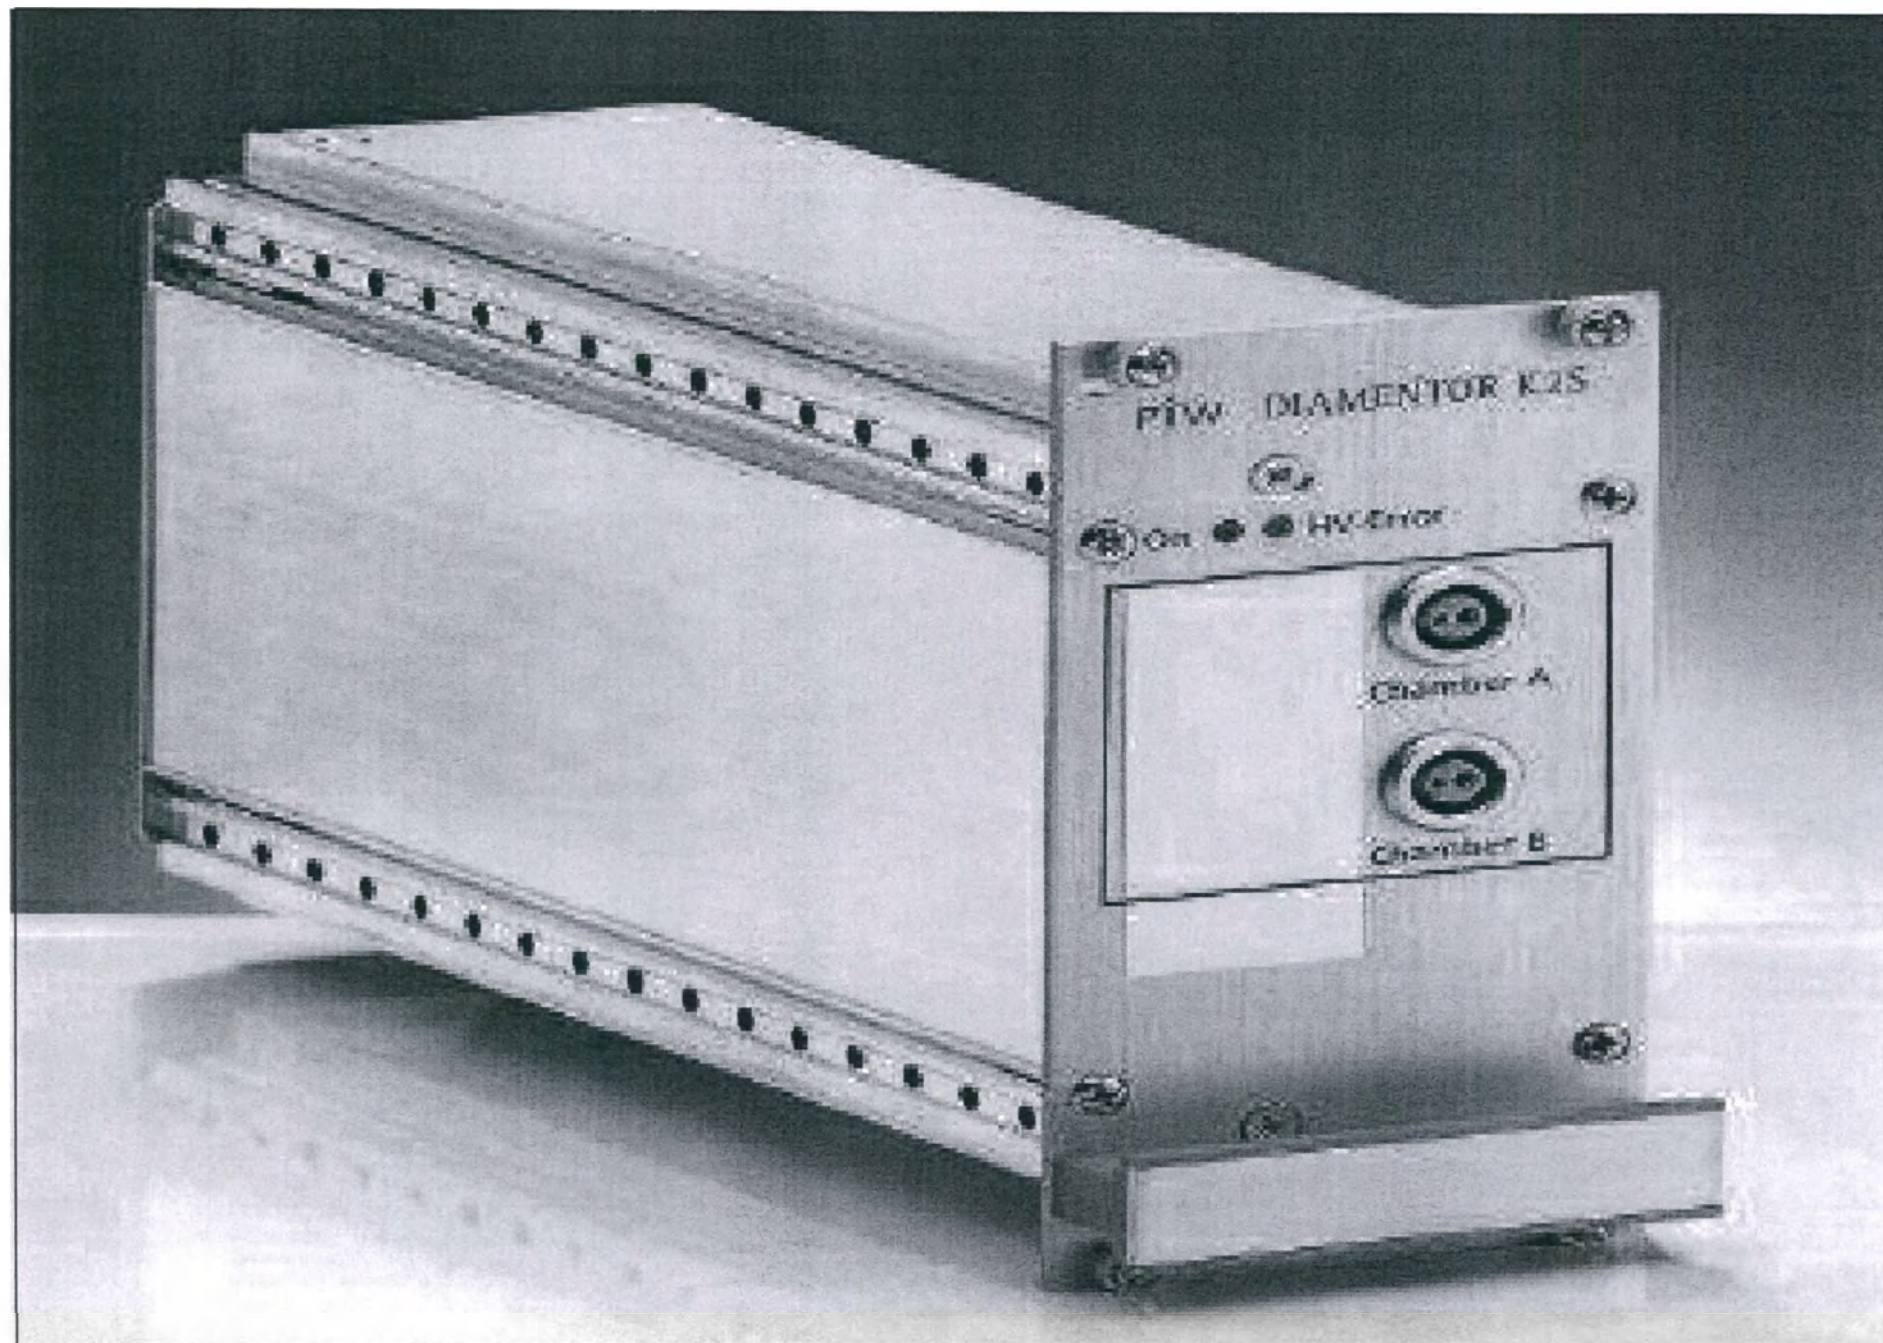


15.а. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

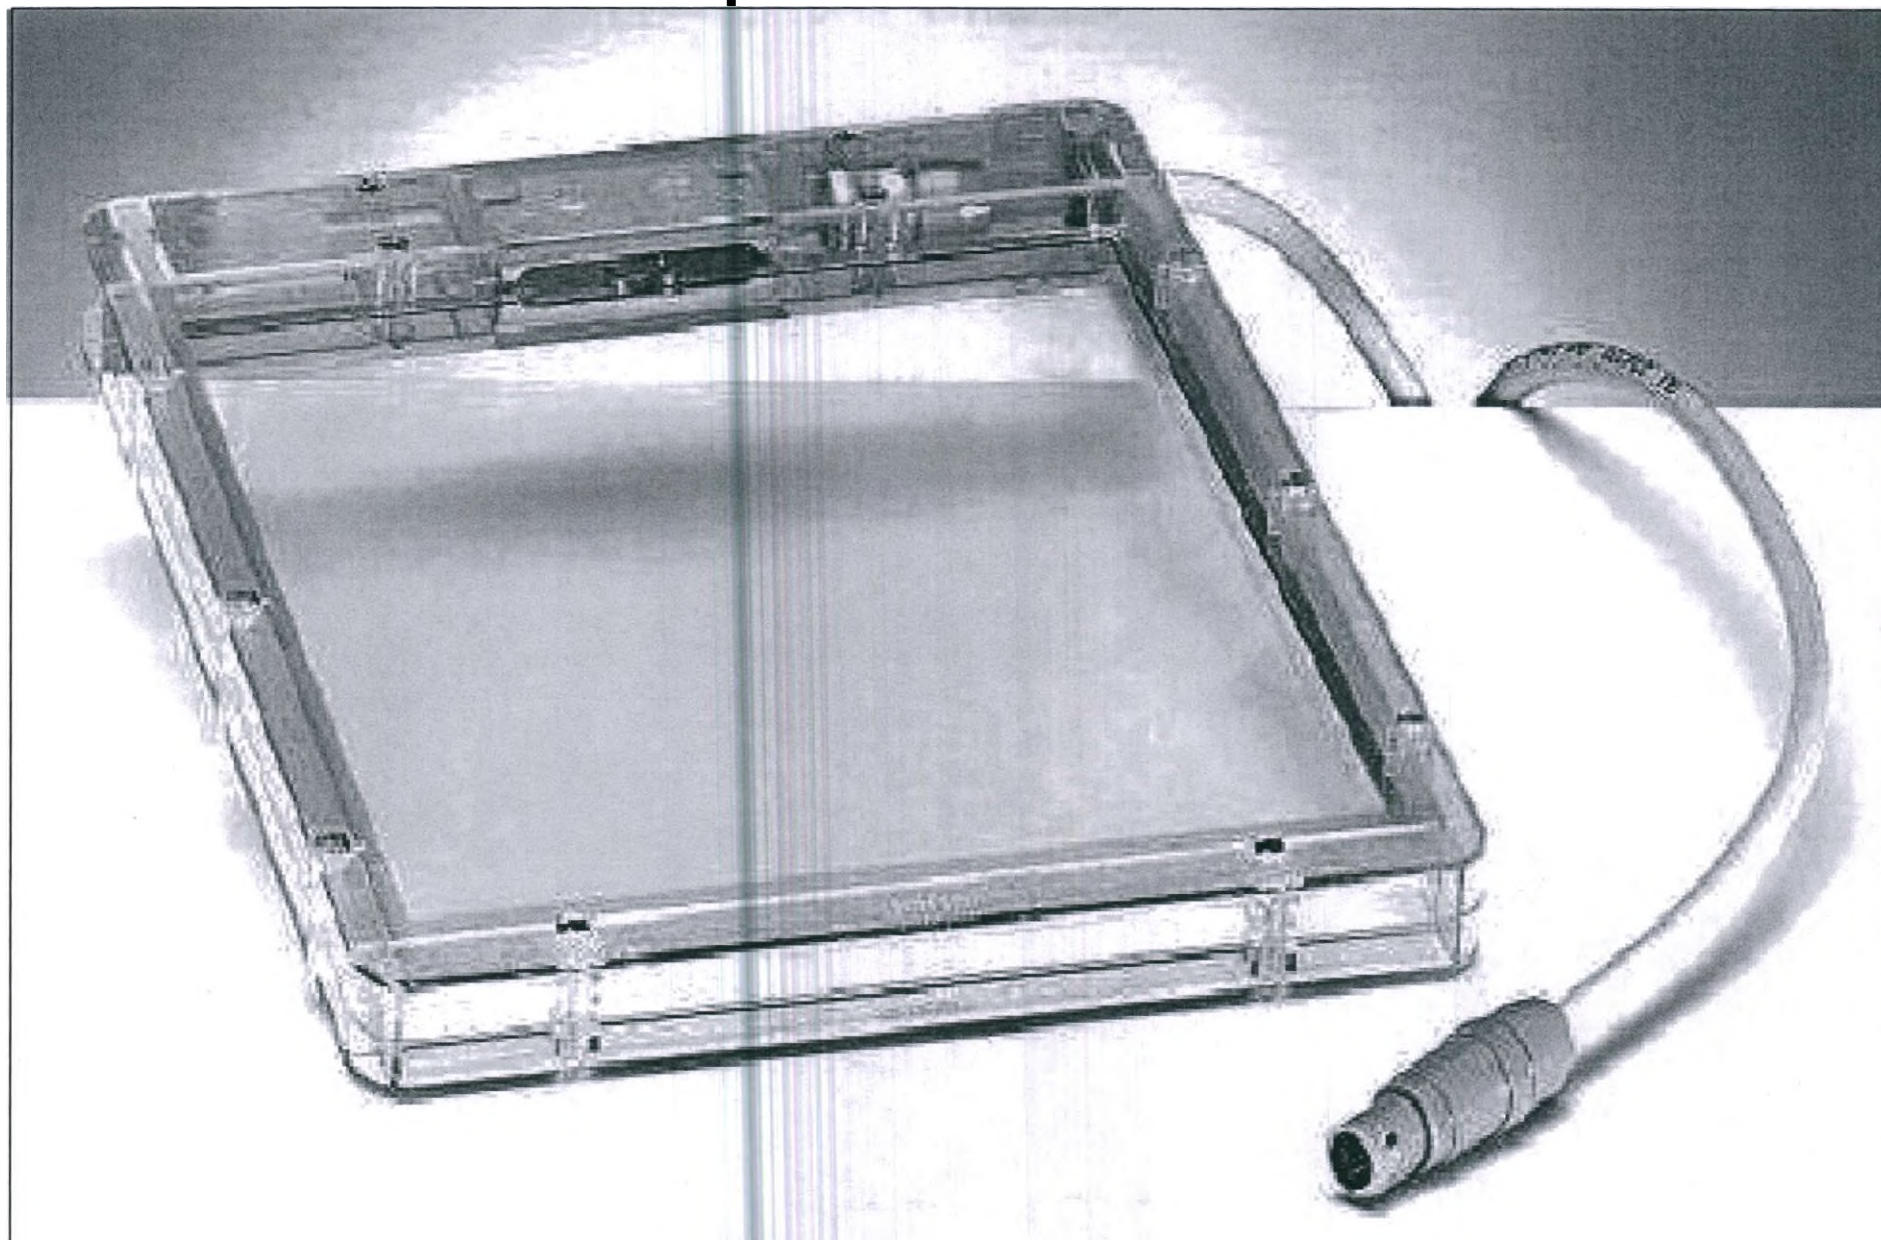


15.6. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

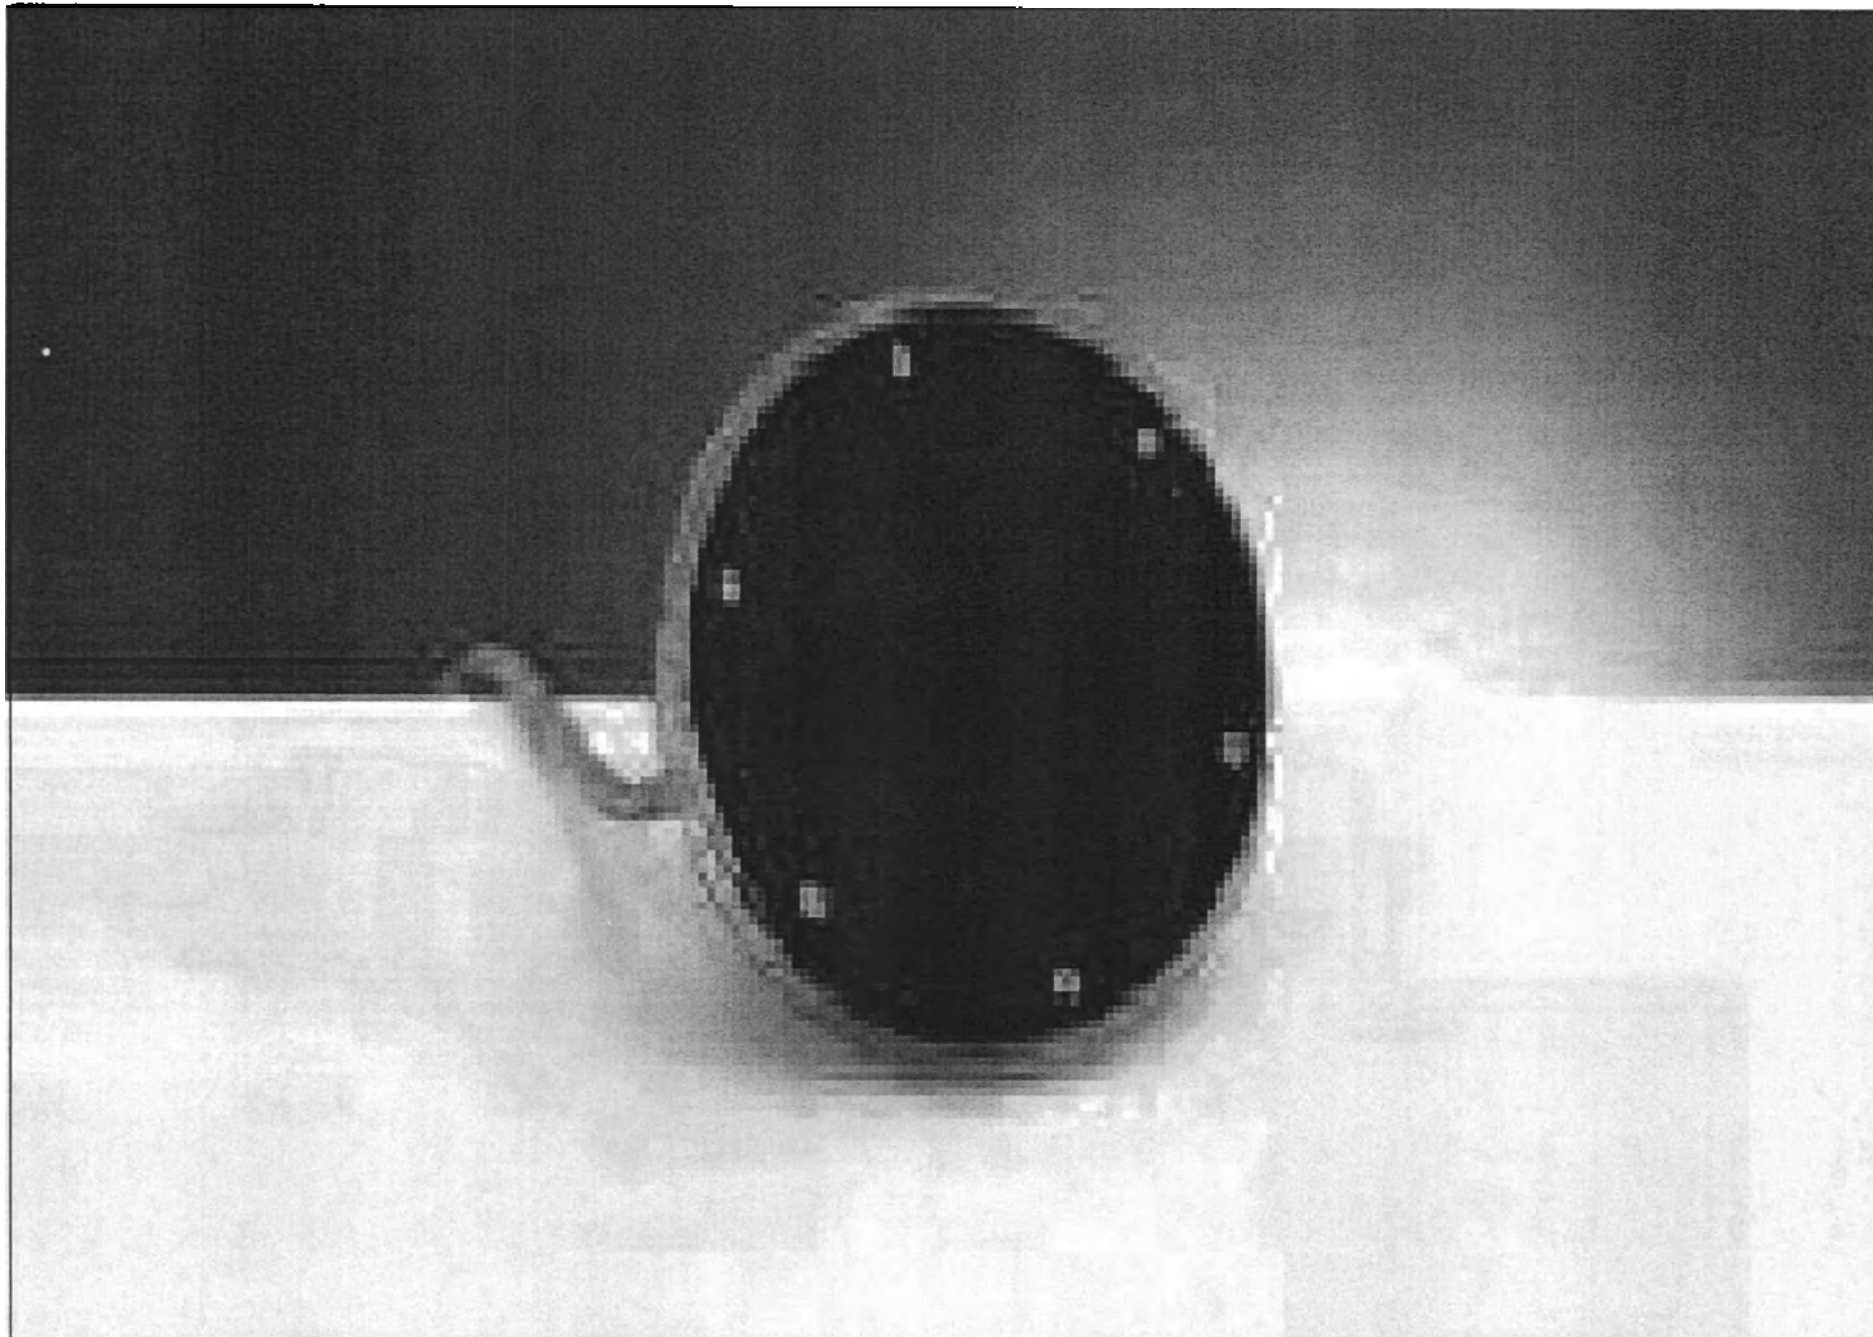


15.в. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или ДРК-1 или ДРК-1М.

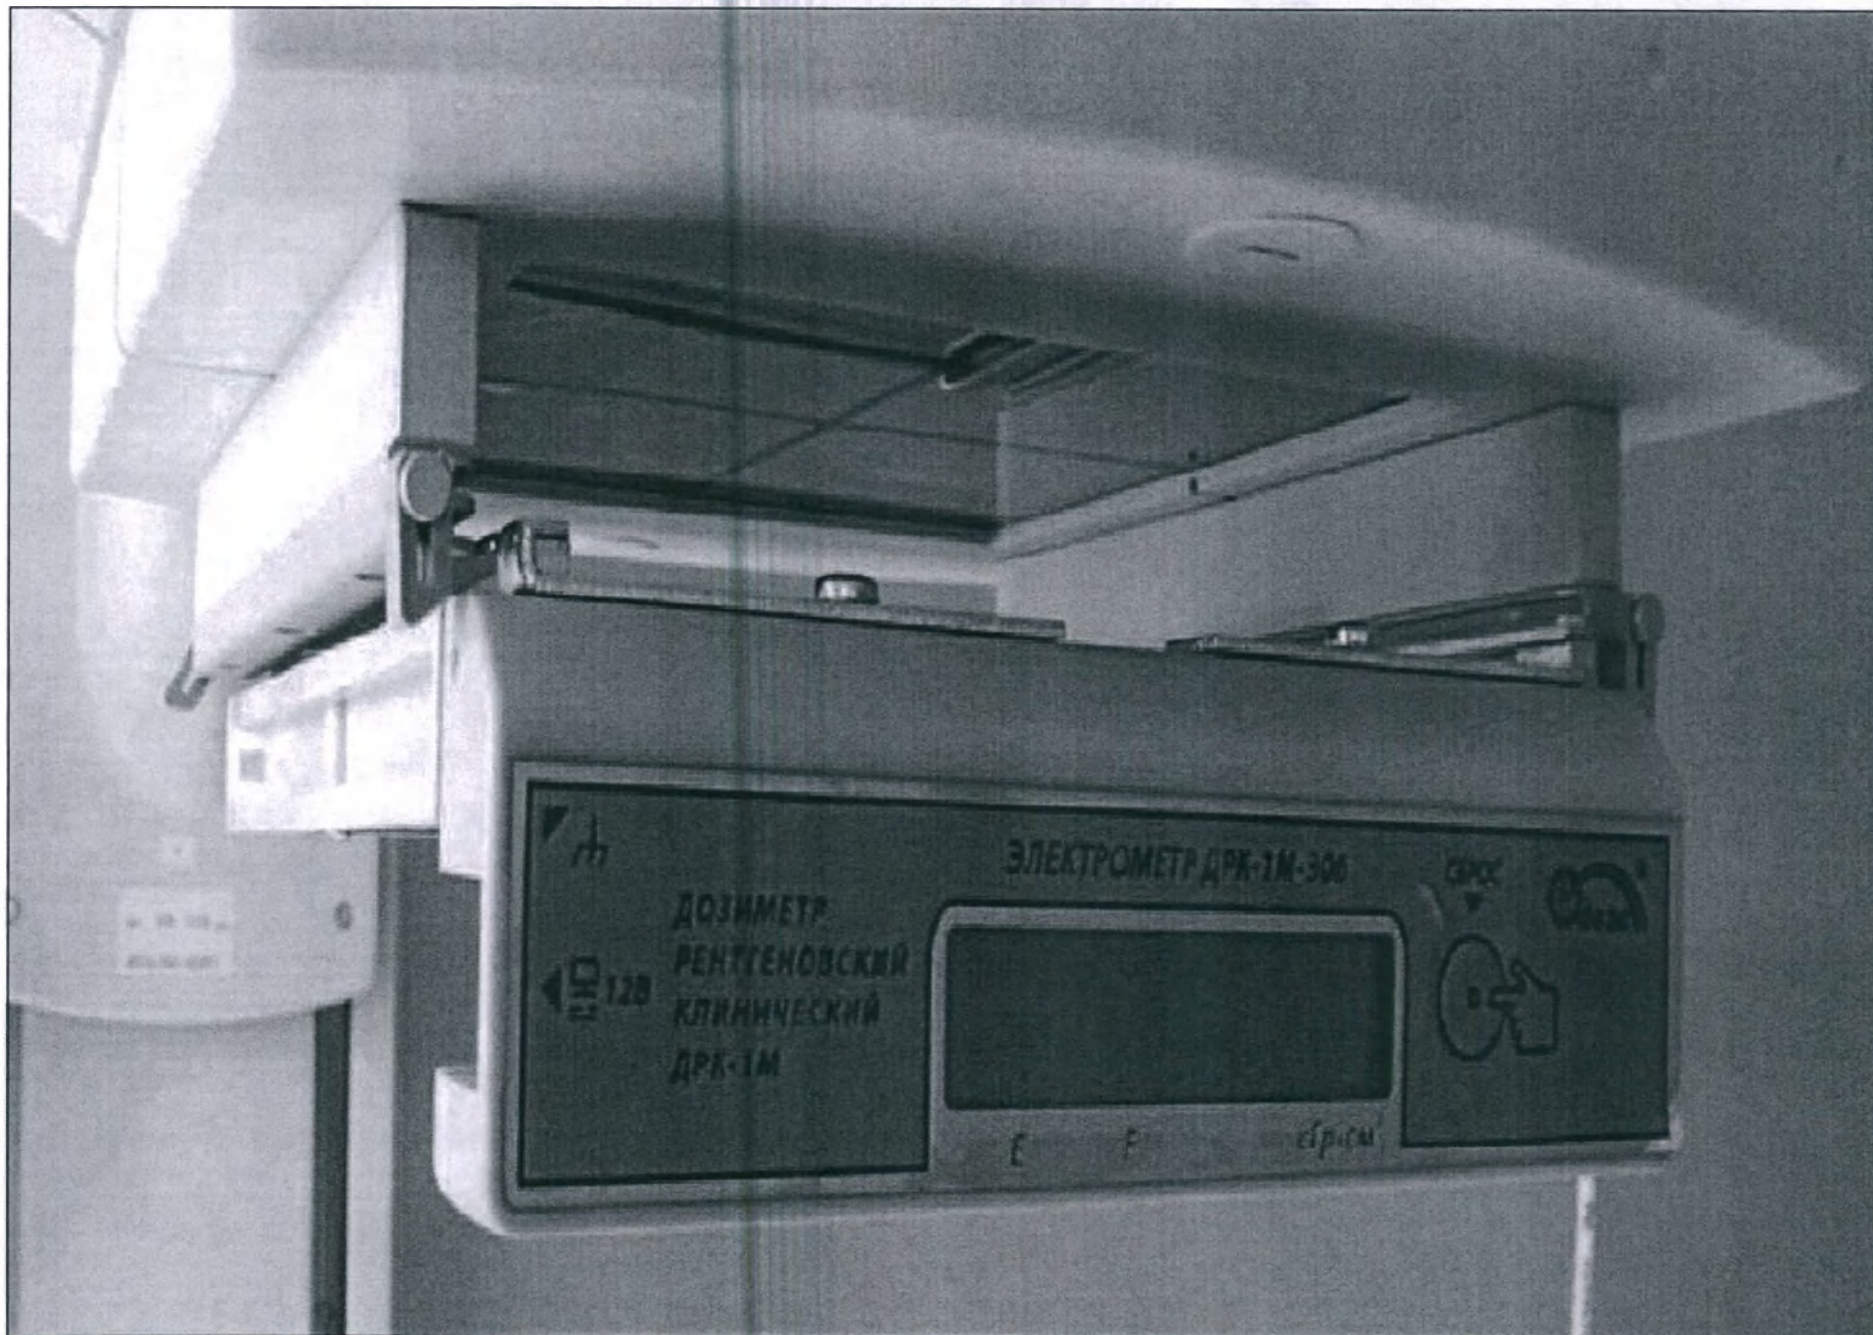


15.г. Дозиметр рентгеновского излучения DIAMENTOR K1S T11028 или DIAMENTOR K2S T11029 или DPRK-1 или DPRK-1M.

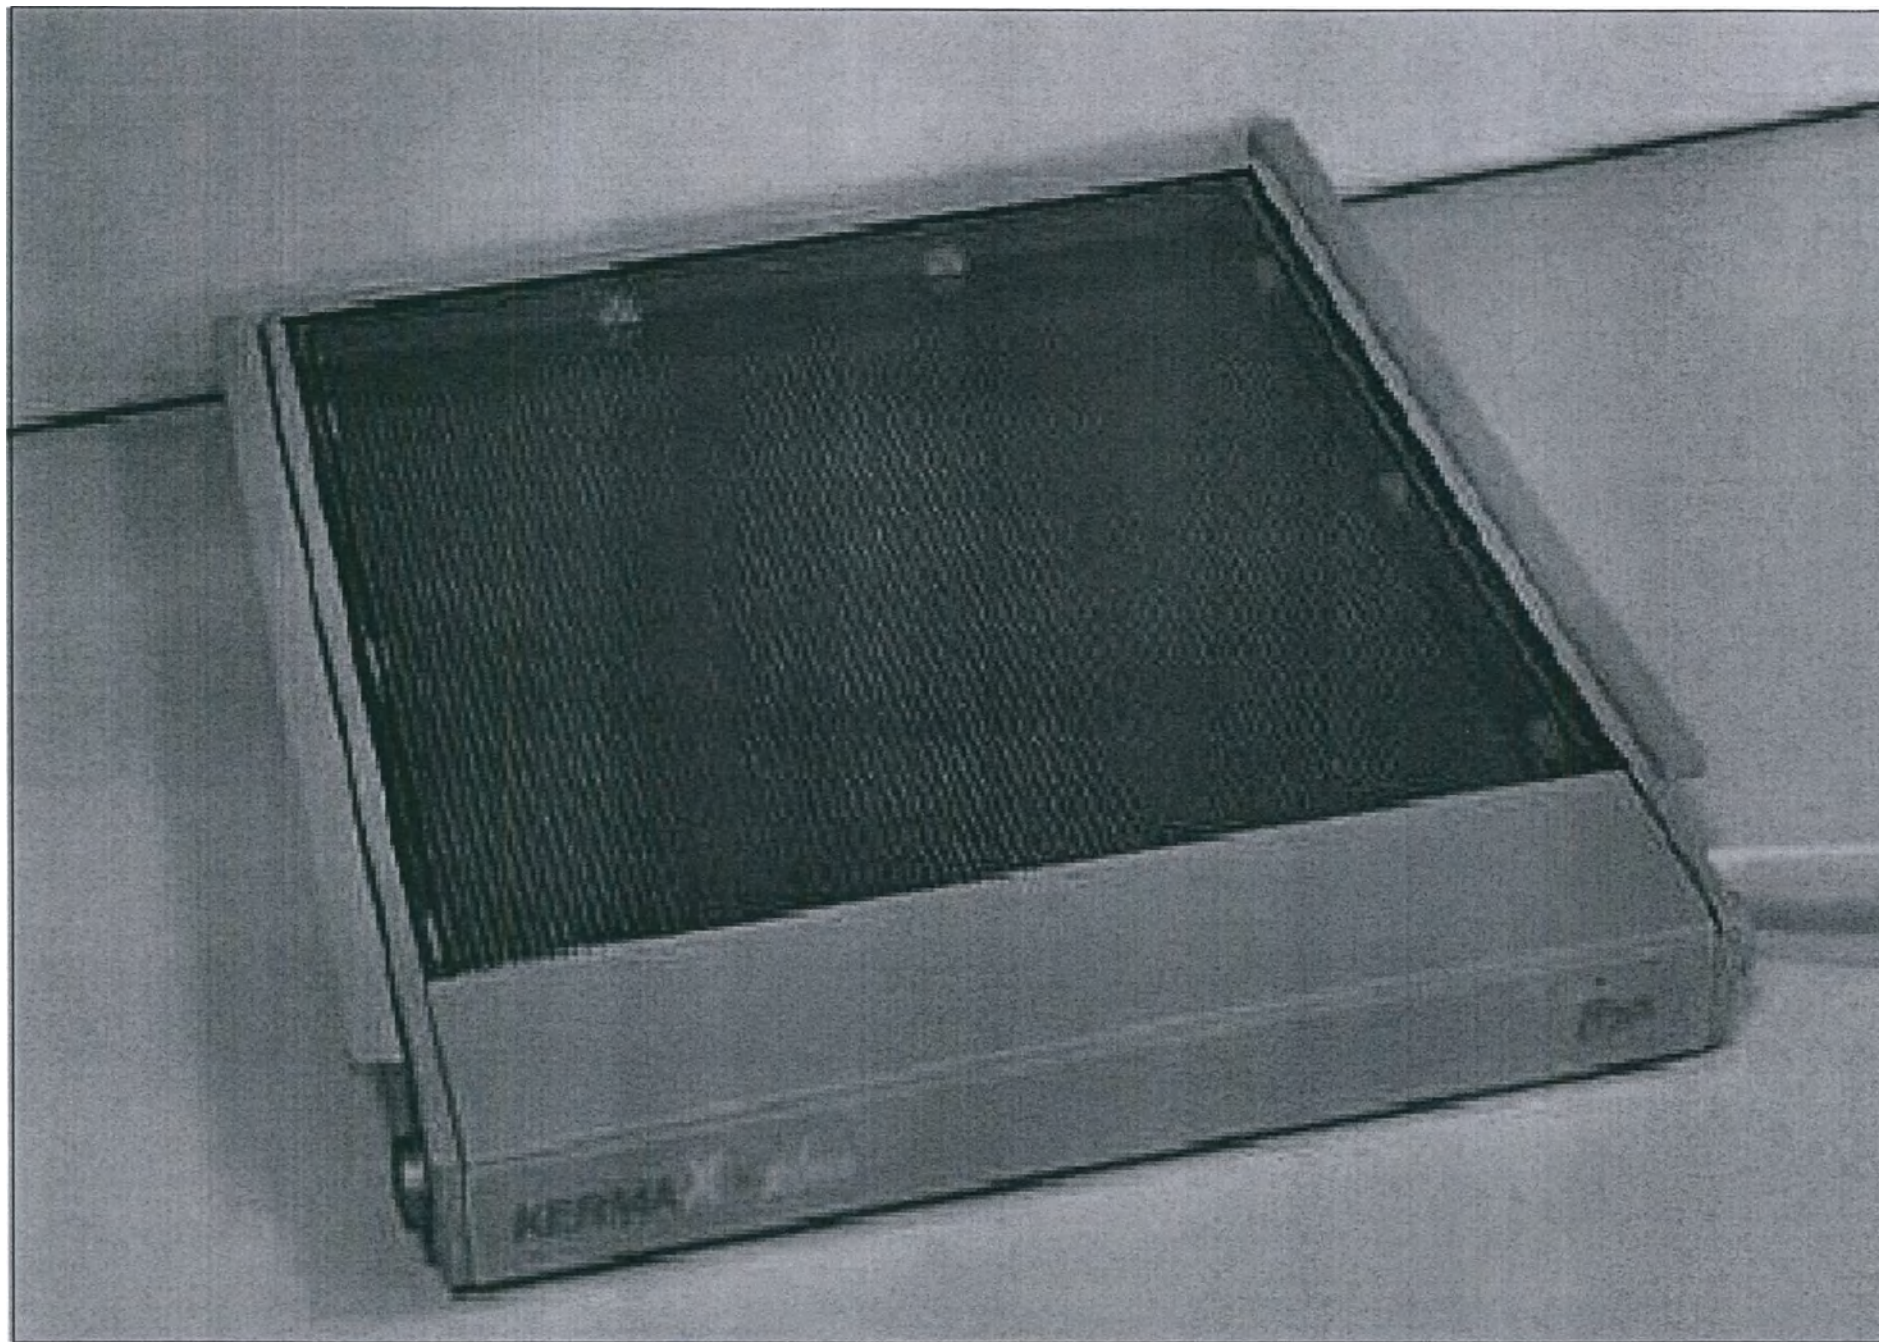


16. Измеритель производства дозы на площадь *KermaX plus 120-132*.

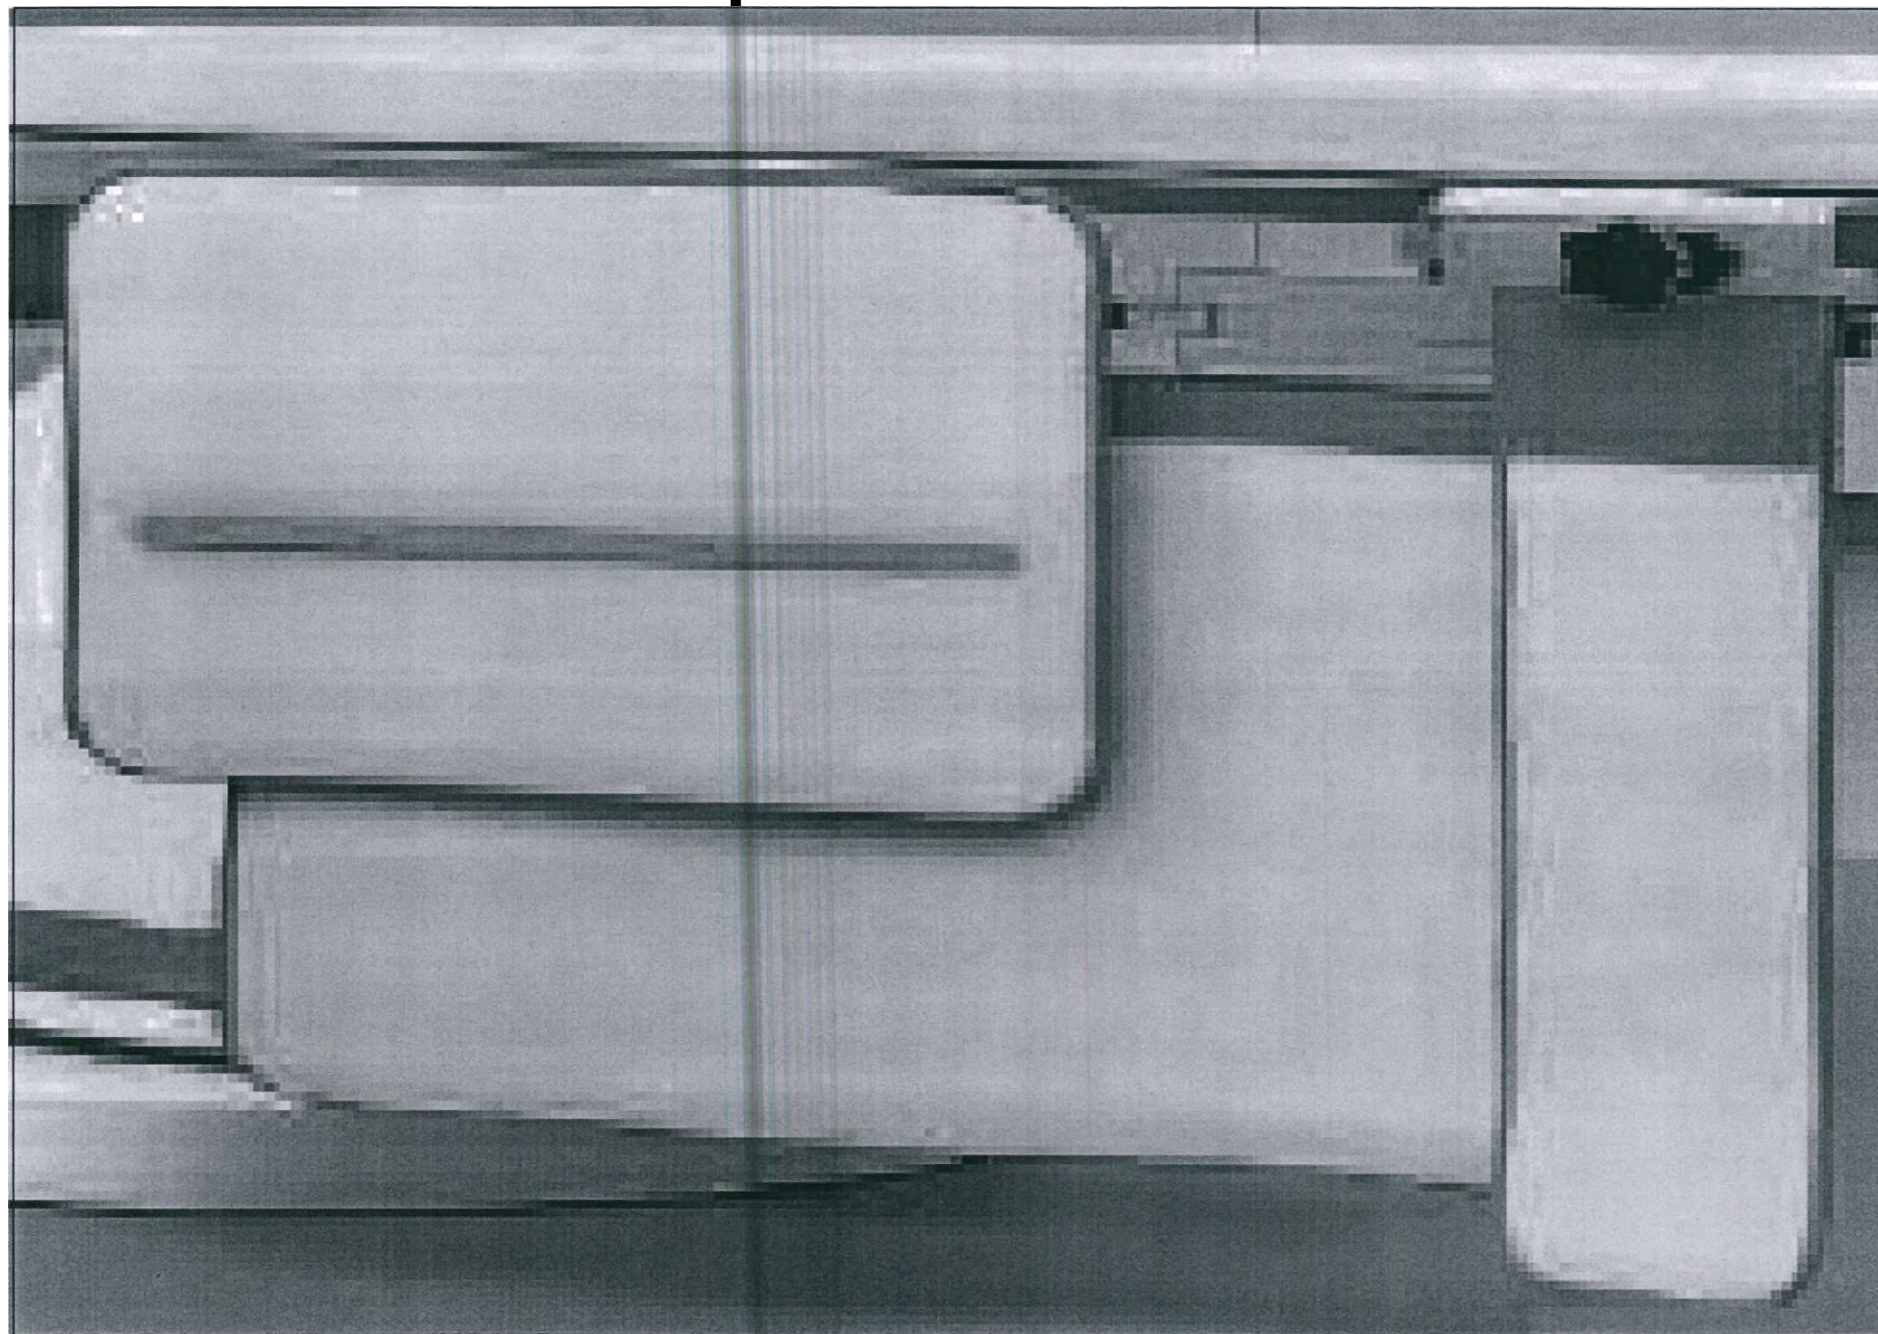


17. Экран радиационной защиты настольный, не более 2 шт.

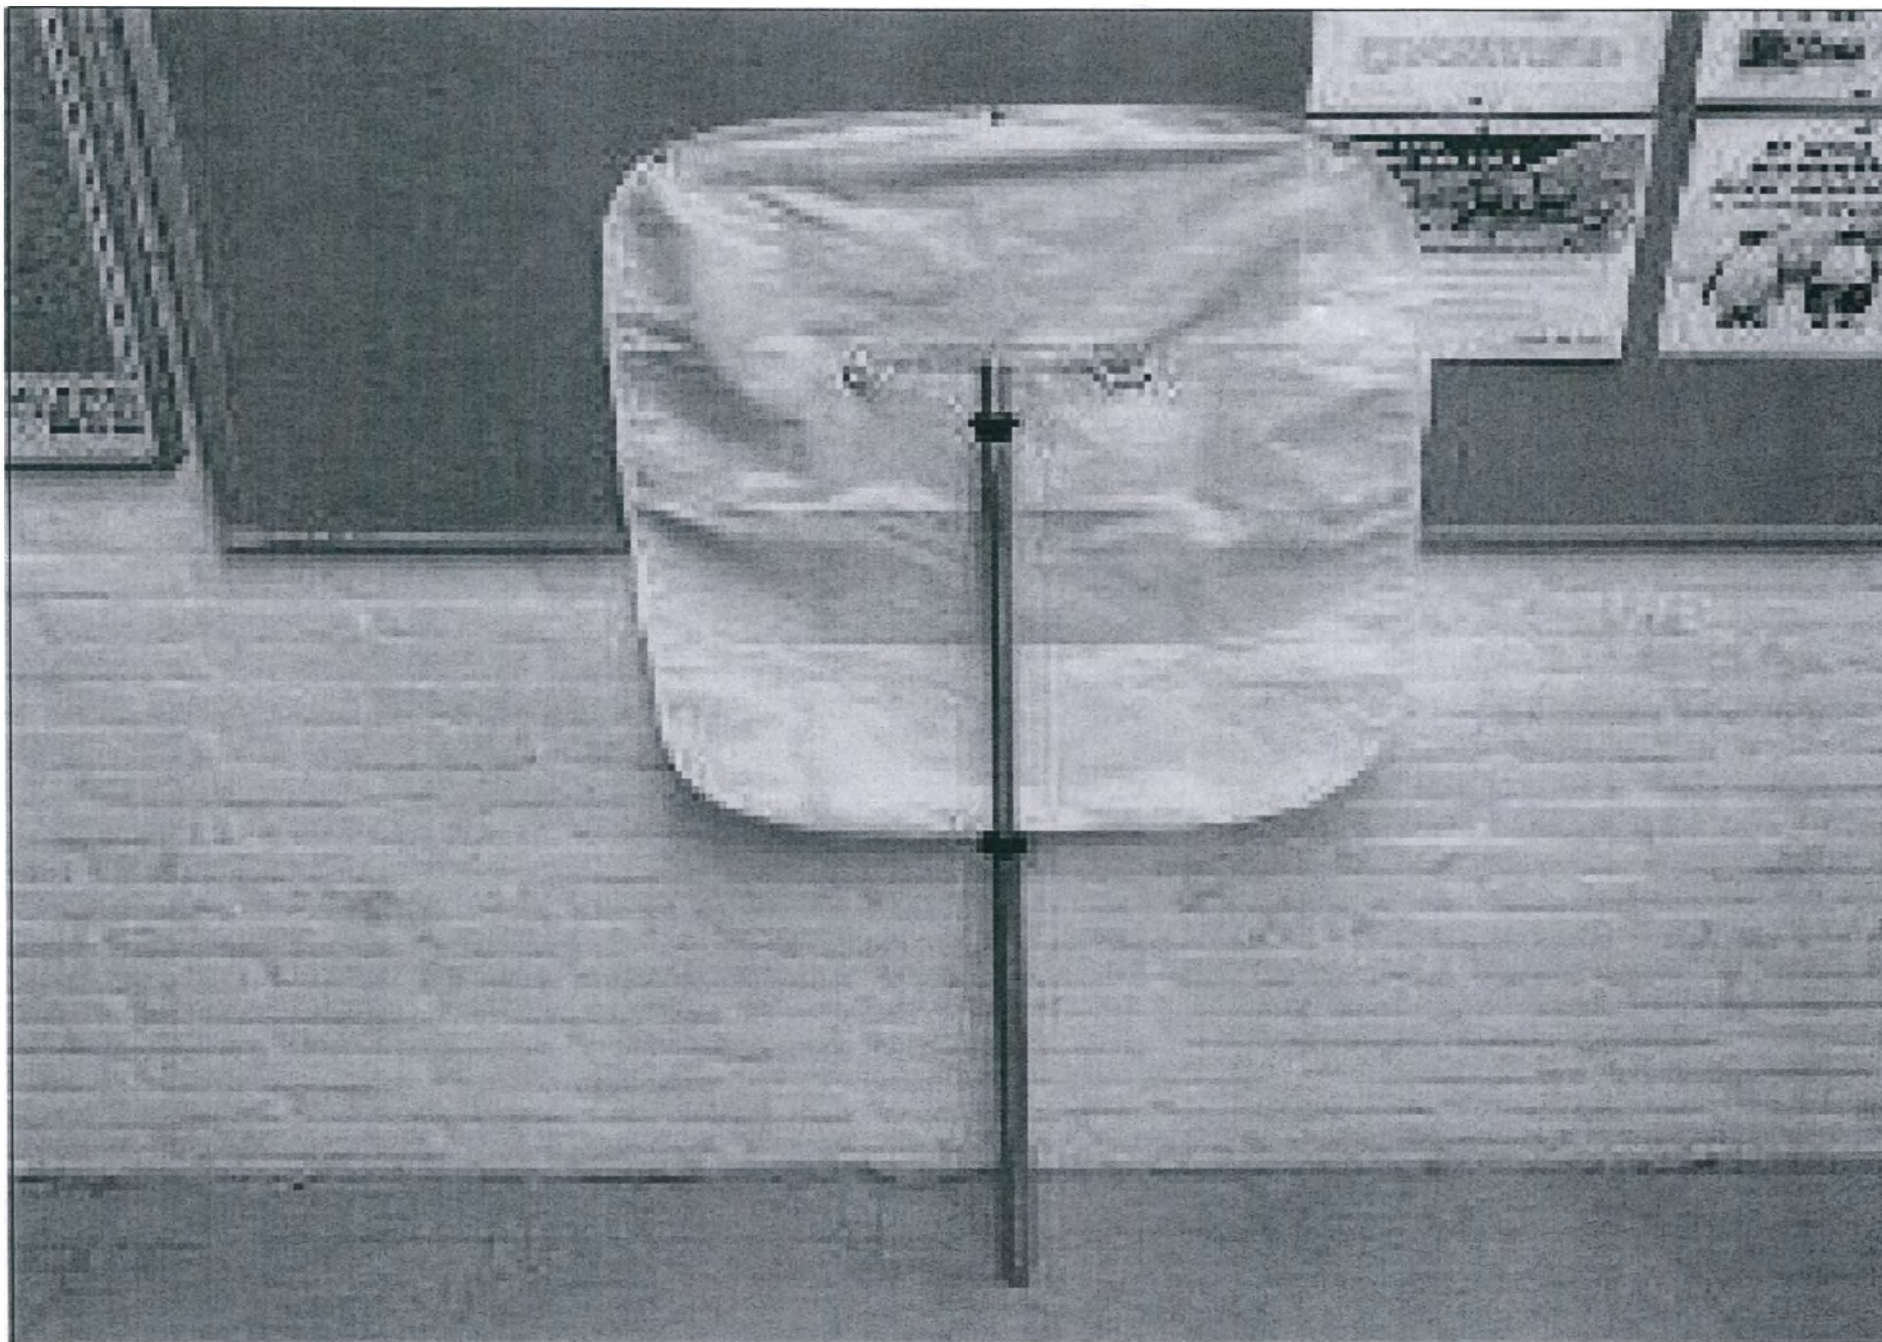


18. Штатив для капельницы, не более 2 шт.

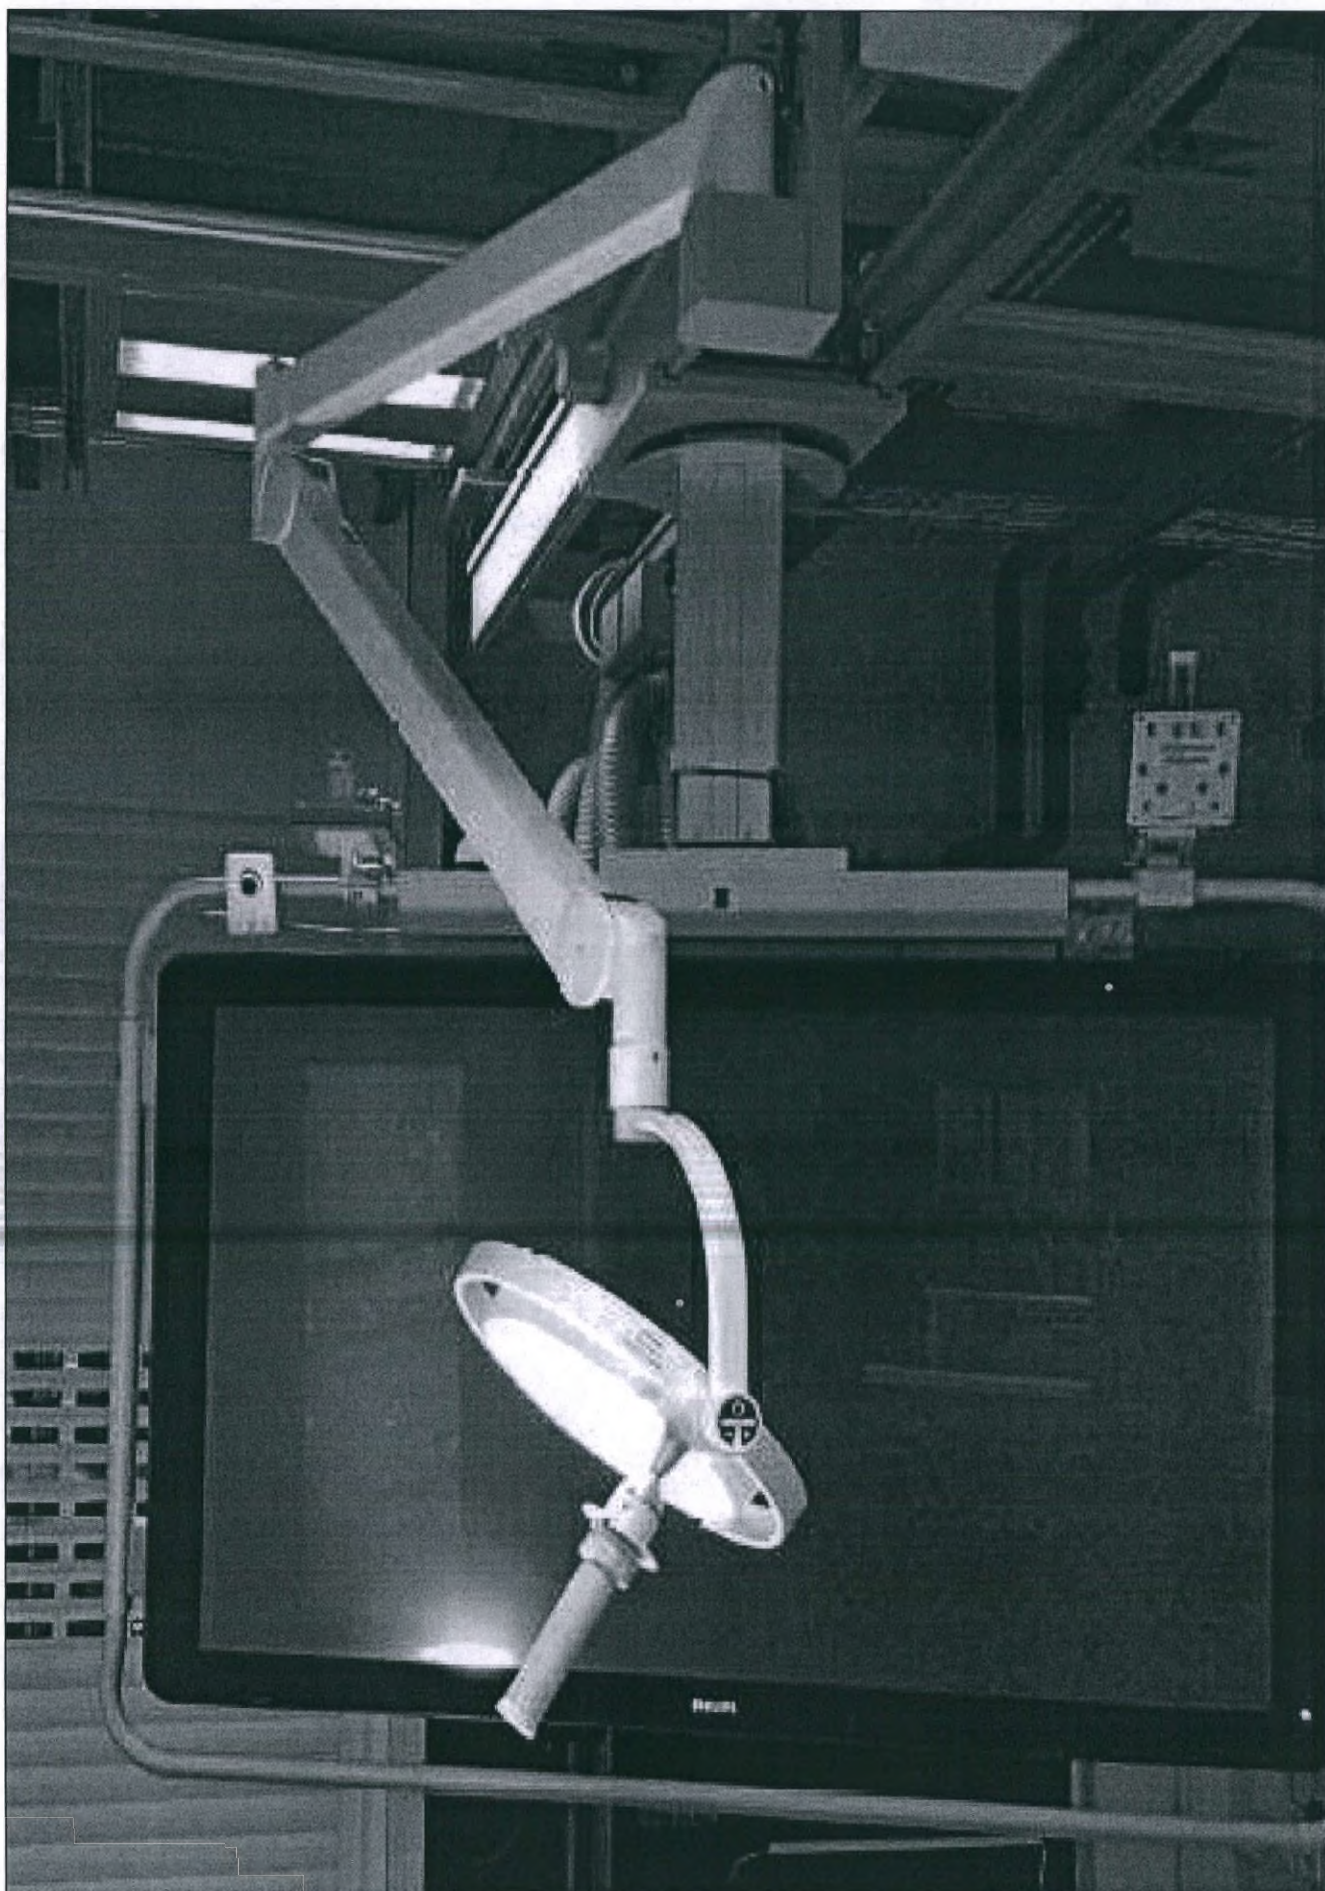

19. Лампа для осмотра

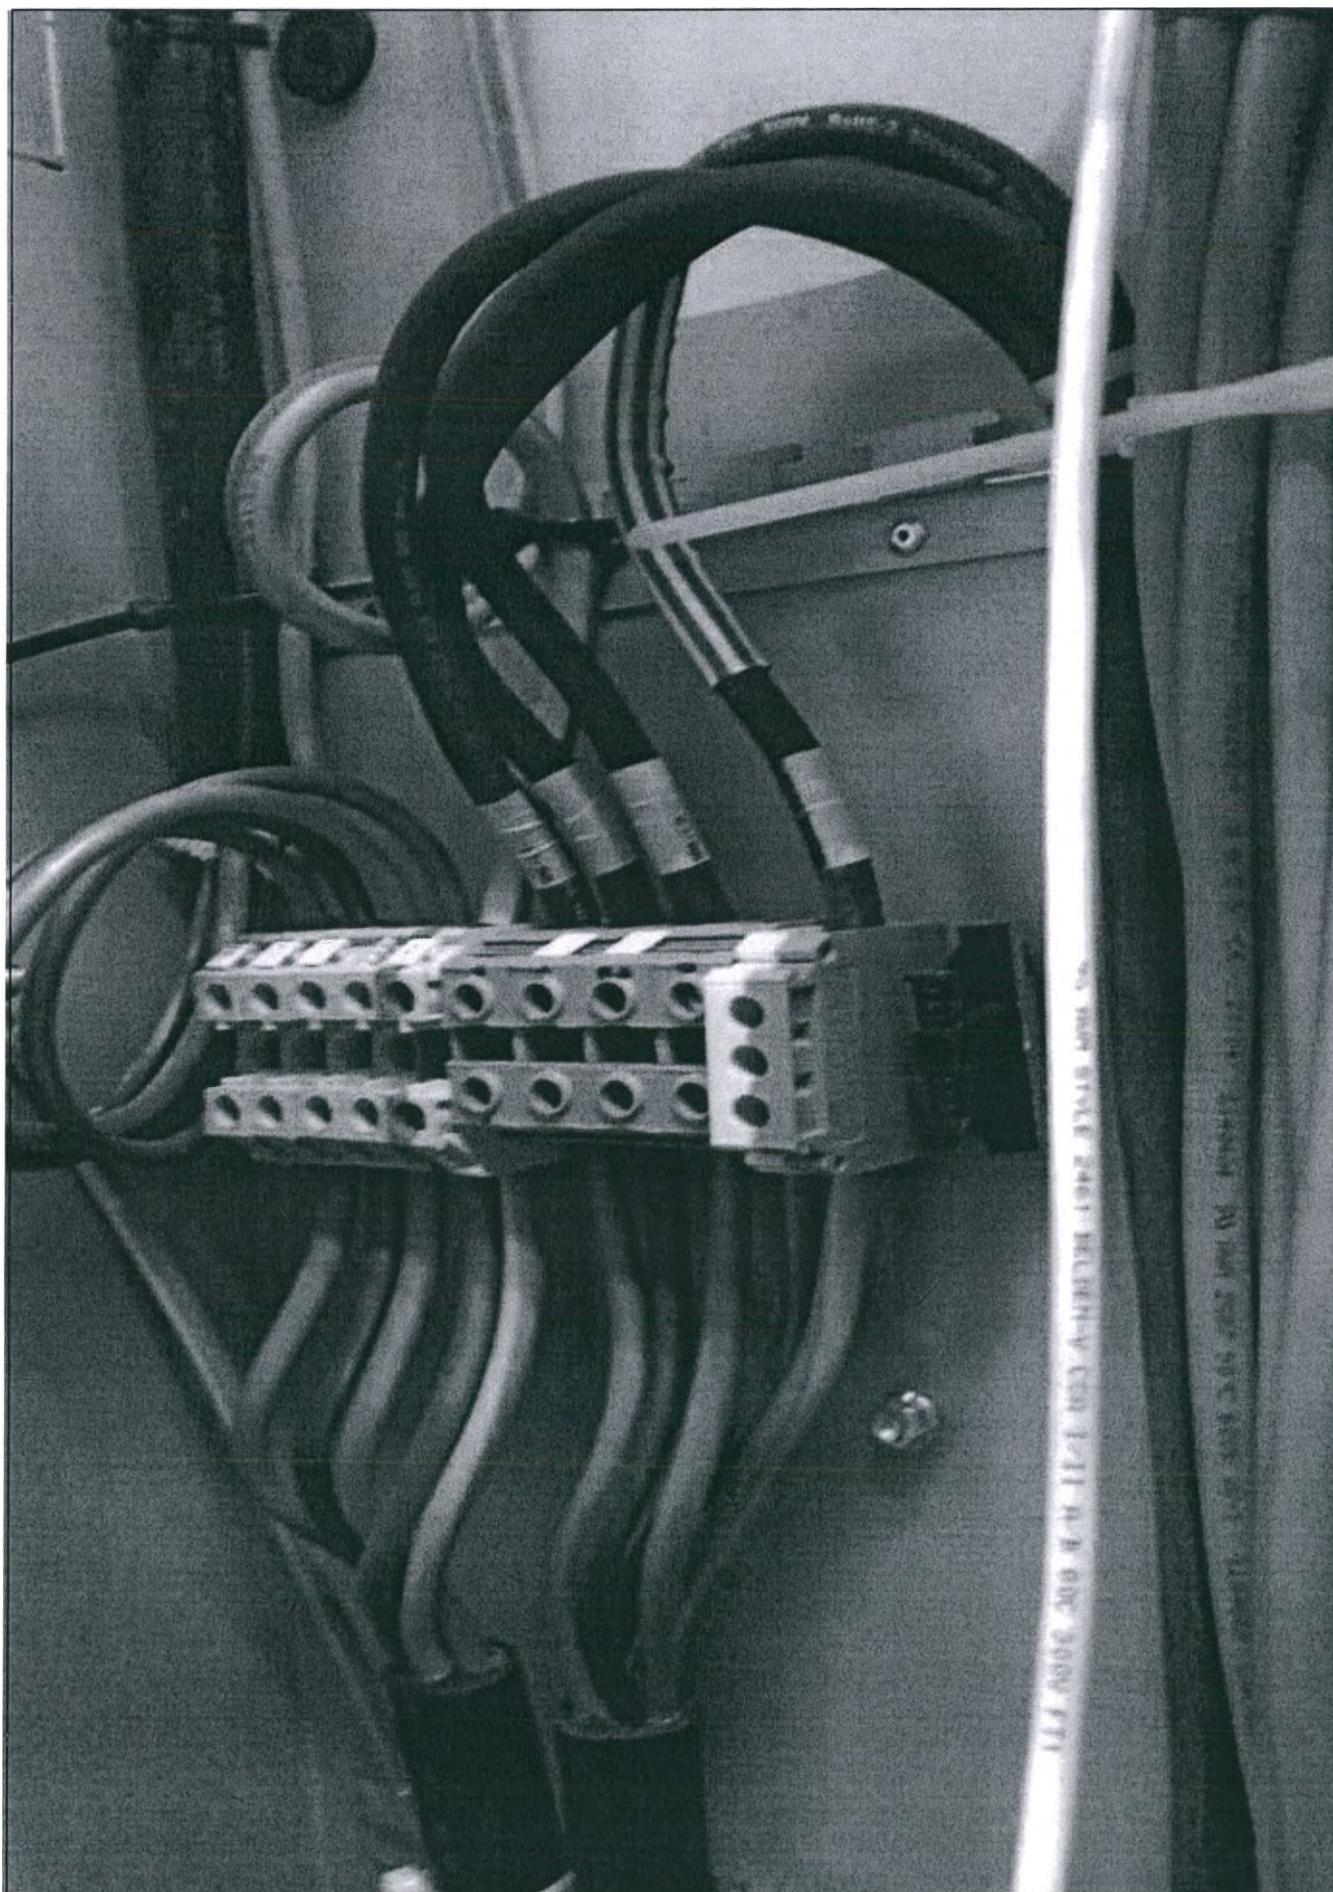

20. Кабели питания, 10 шт.

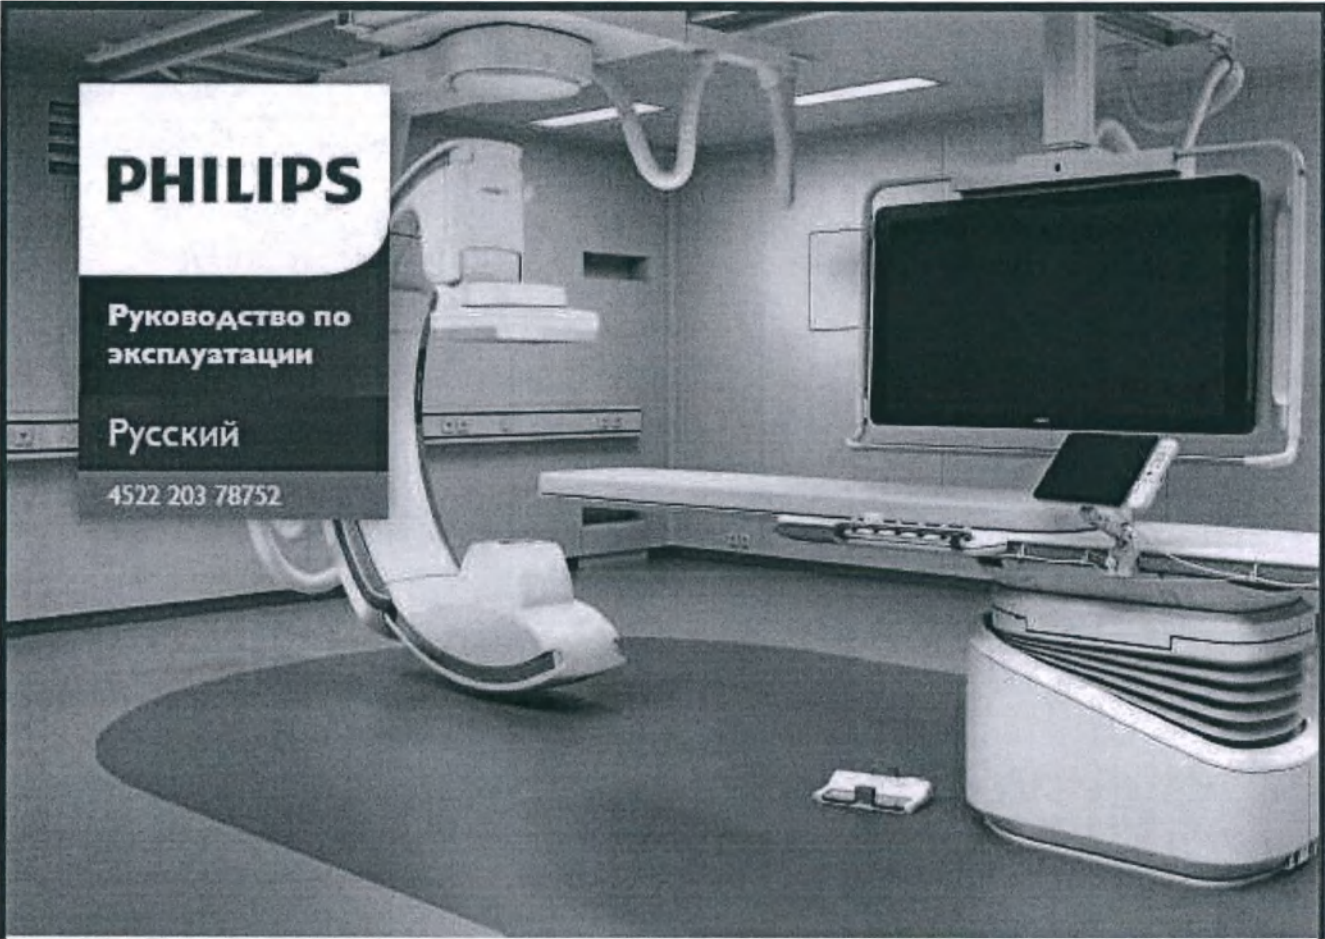

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации


Русский

4522 203 78752

Philips Azurion

Версия 2.1

21.а. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.

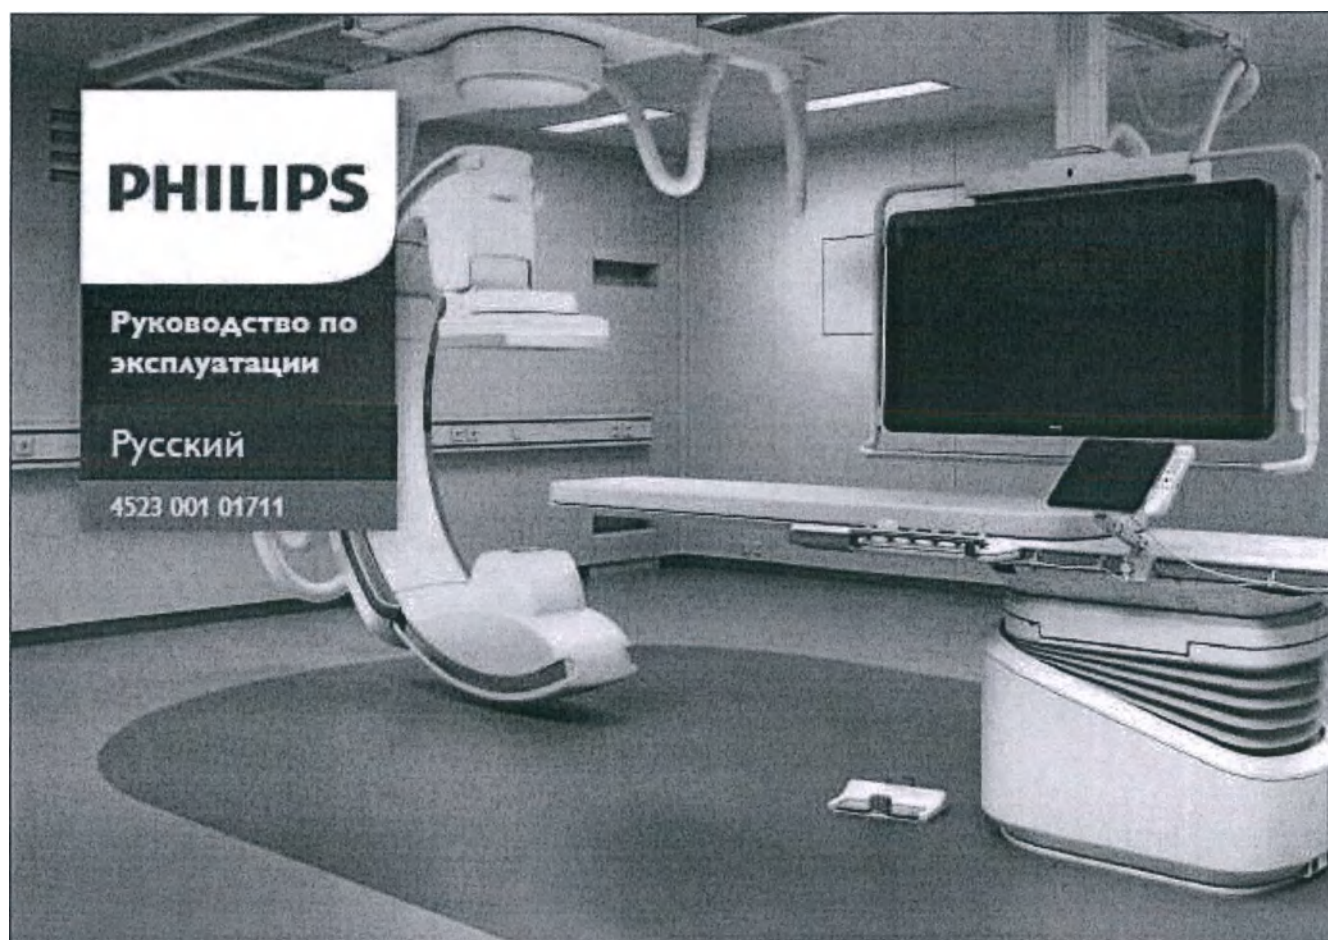

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский

4523 001 01711

Philips Azurion


Версия 2.2

21. 6. Руководства по эксплуатации на бумажных носителях, не более 25 шт.

Принадлежности:



1. Столик для мыши.

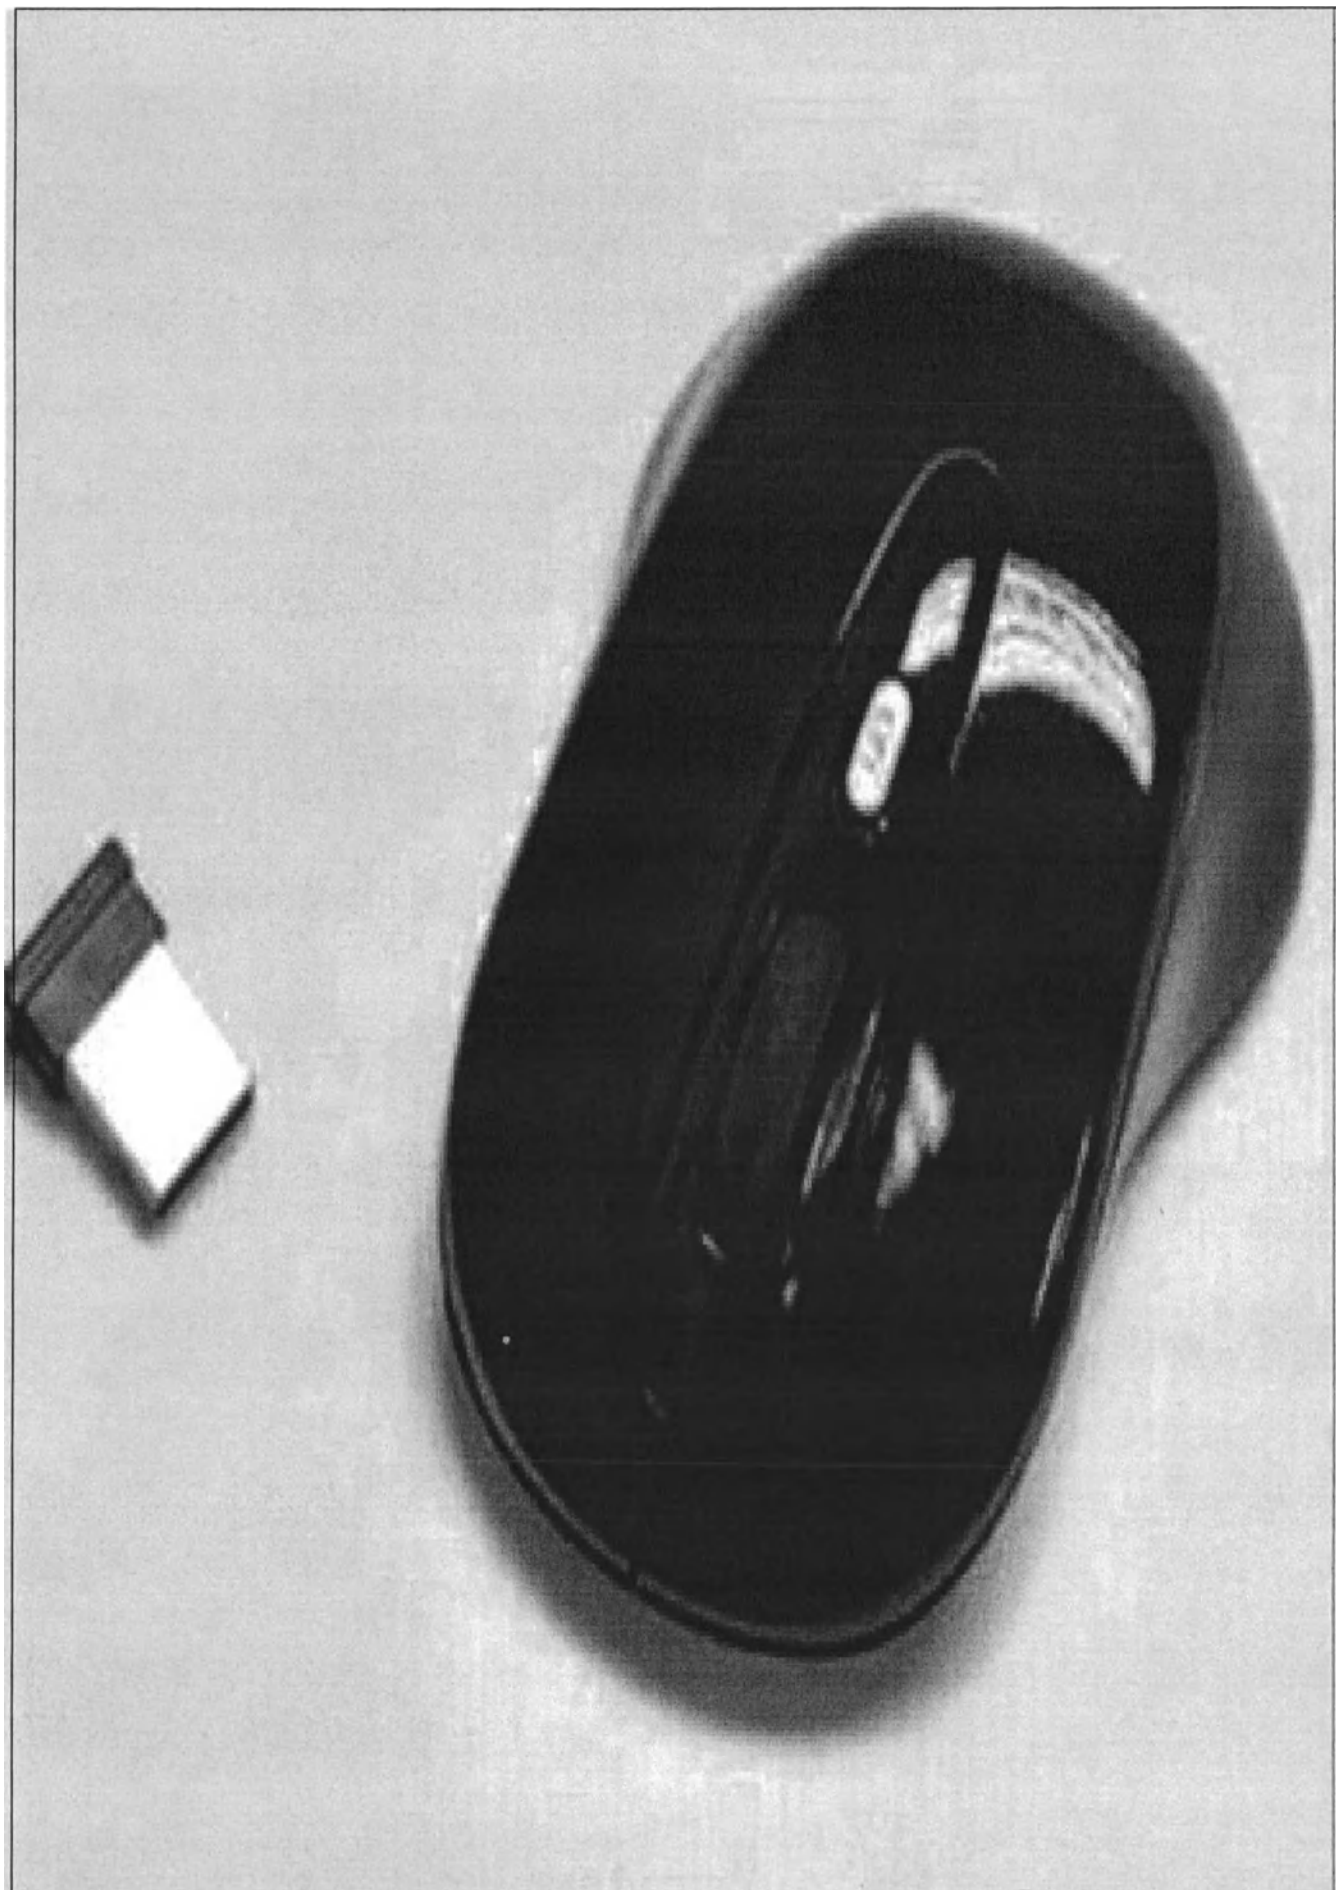


2. Беспроводная мышь



3. Ручка перемещения стола




4. Беспроводной ножной переключатель.

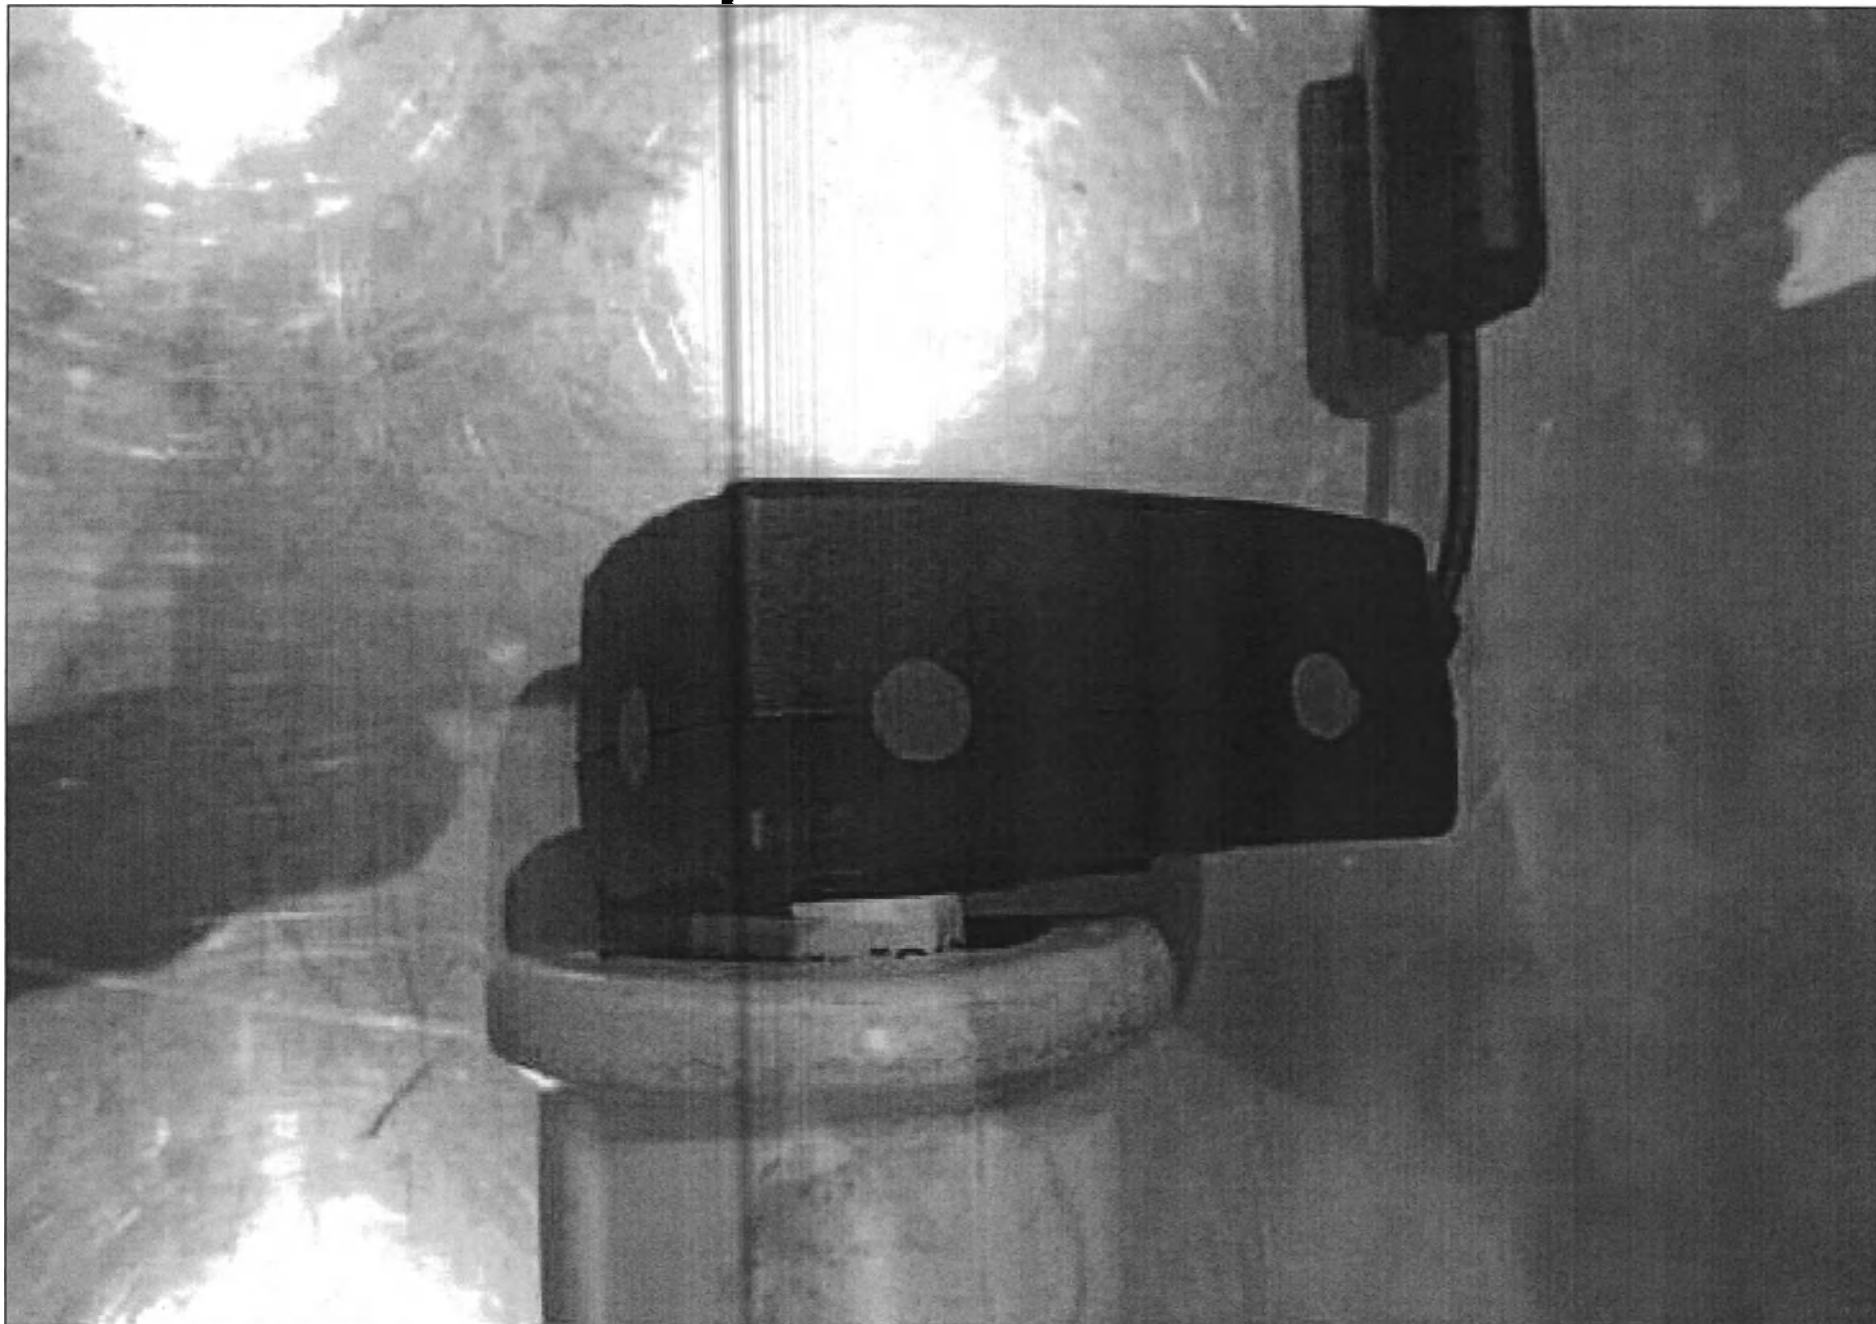


5.а. Зарядное устройство беспроводного ножного переключателя.



5.6. Зарядное устройство беспроводного ножного переключателя.

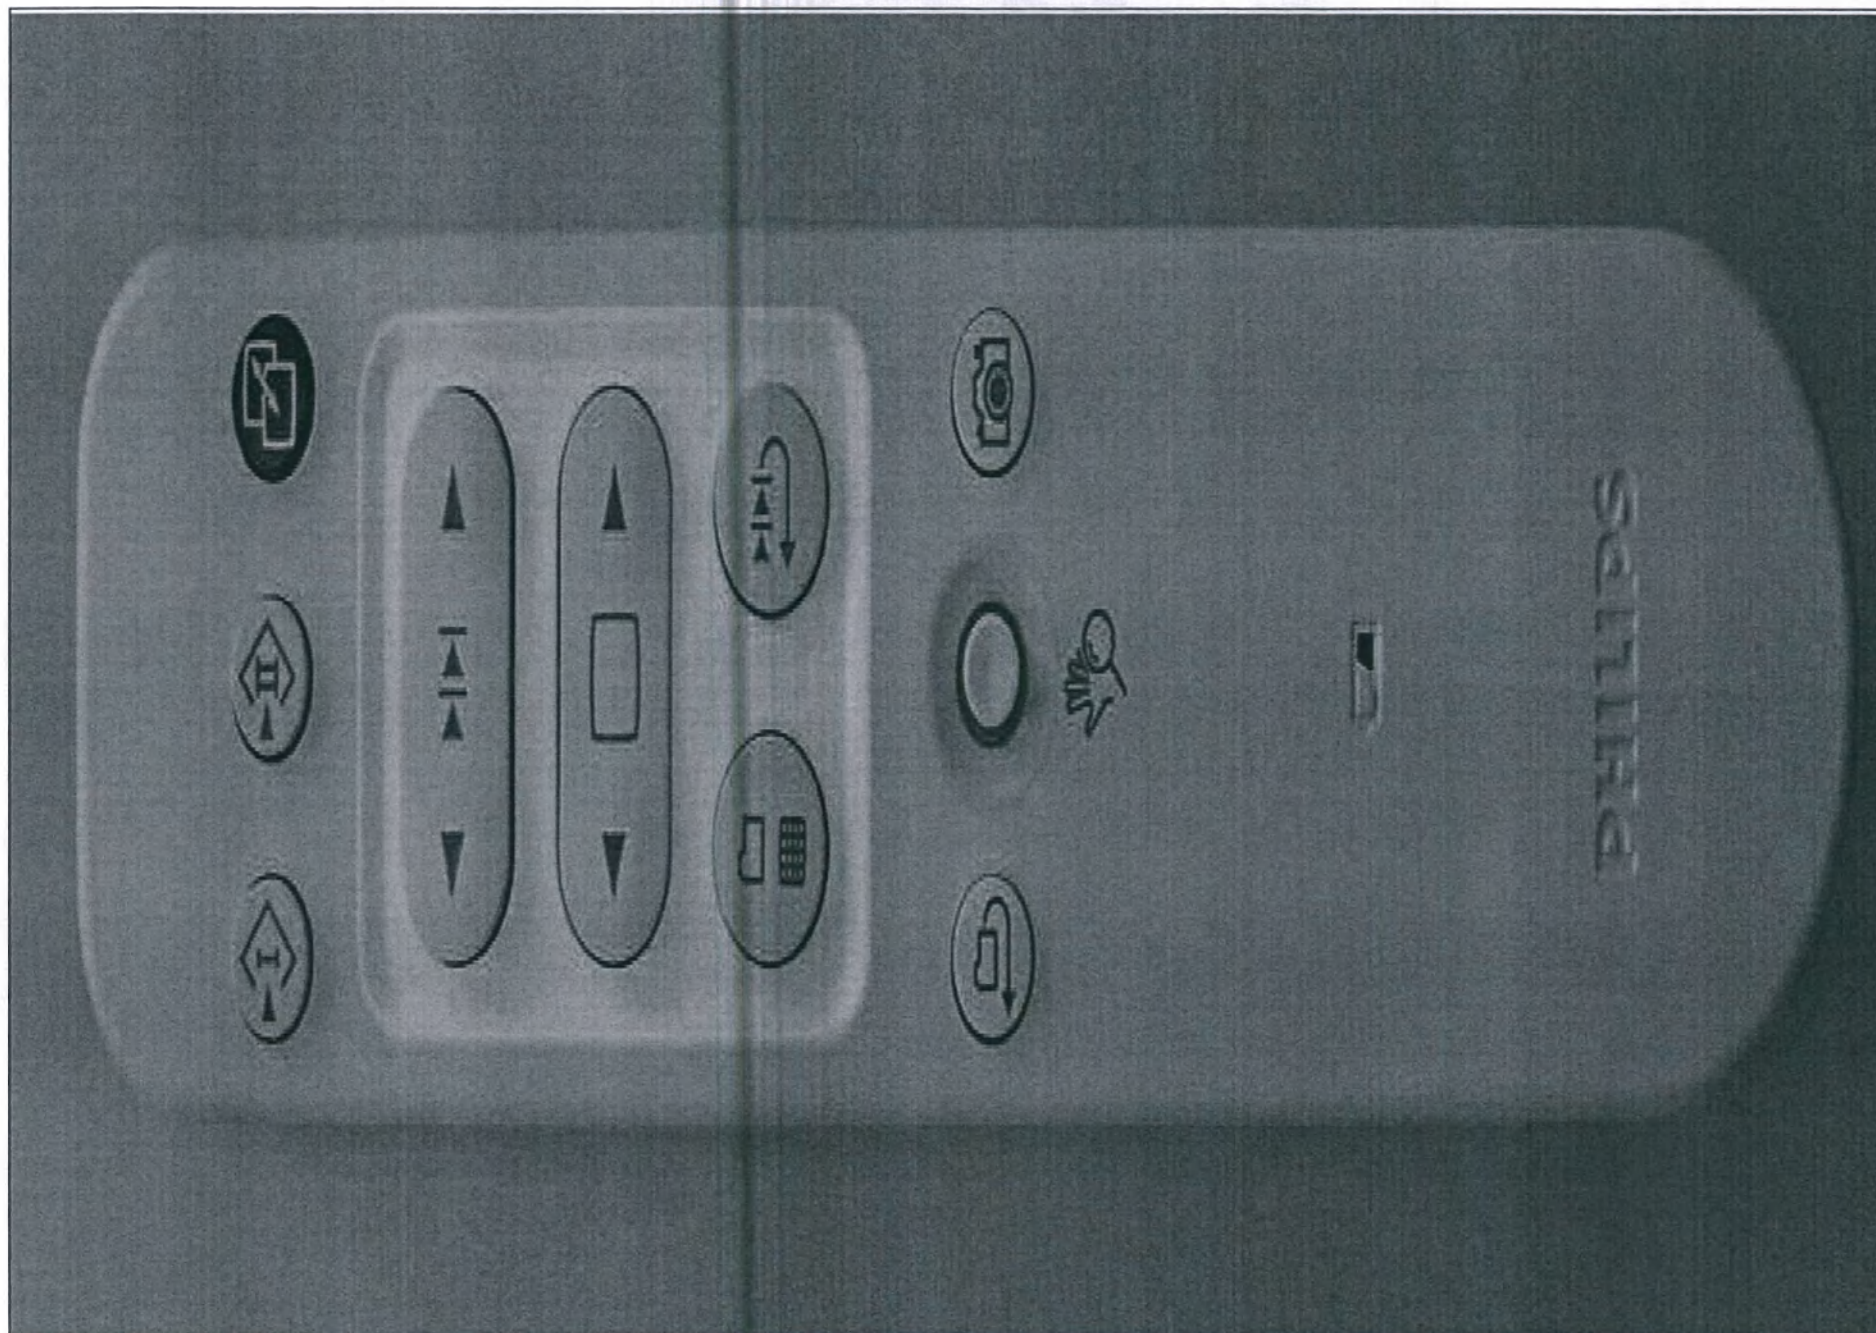


6. Пульт дистанционного управления для исследования сердца

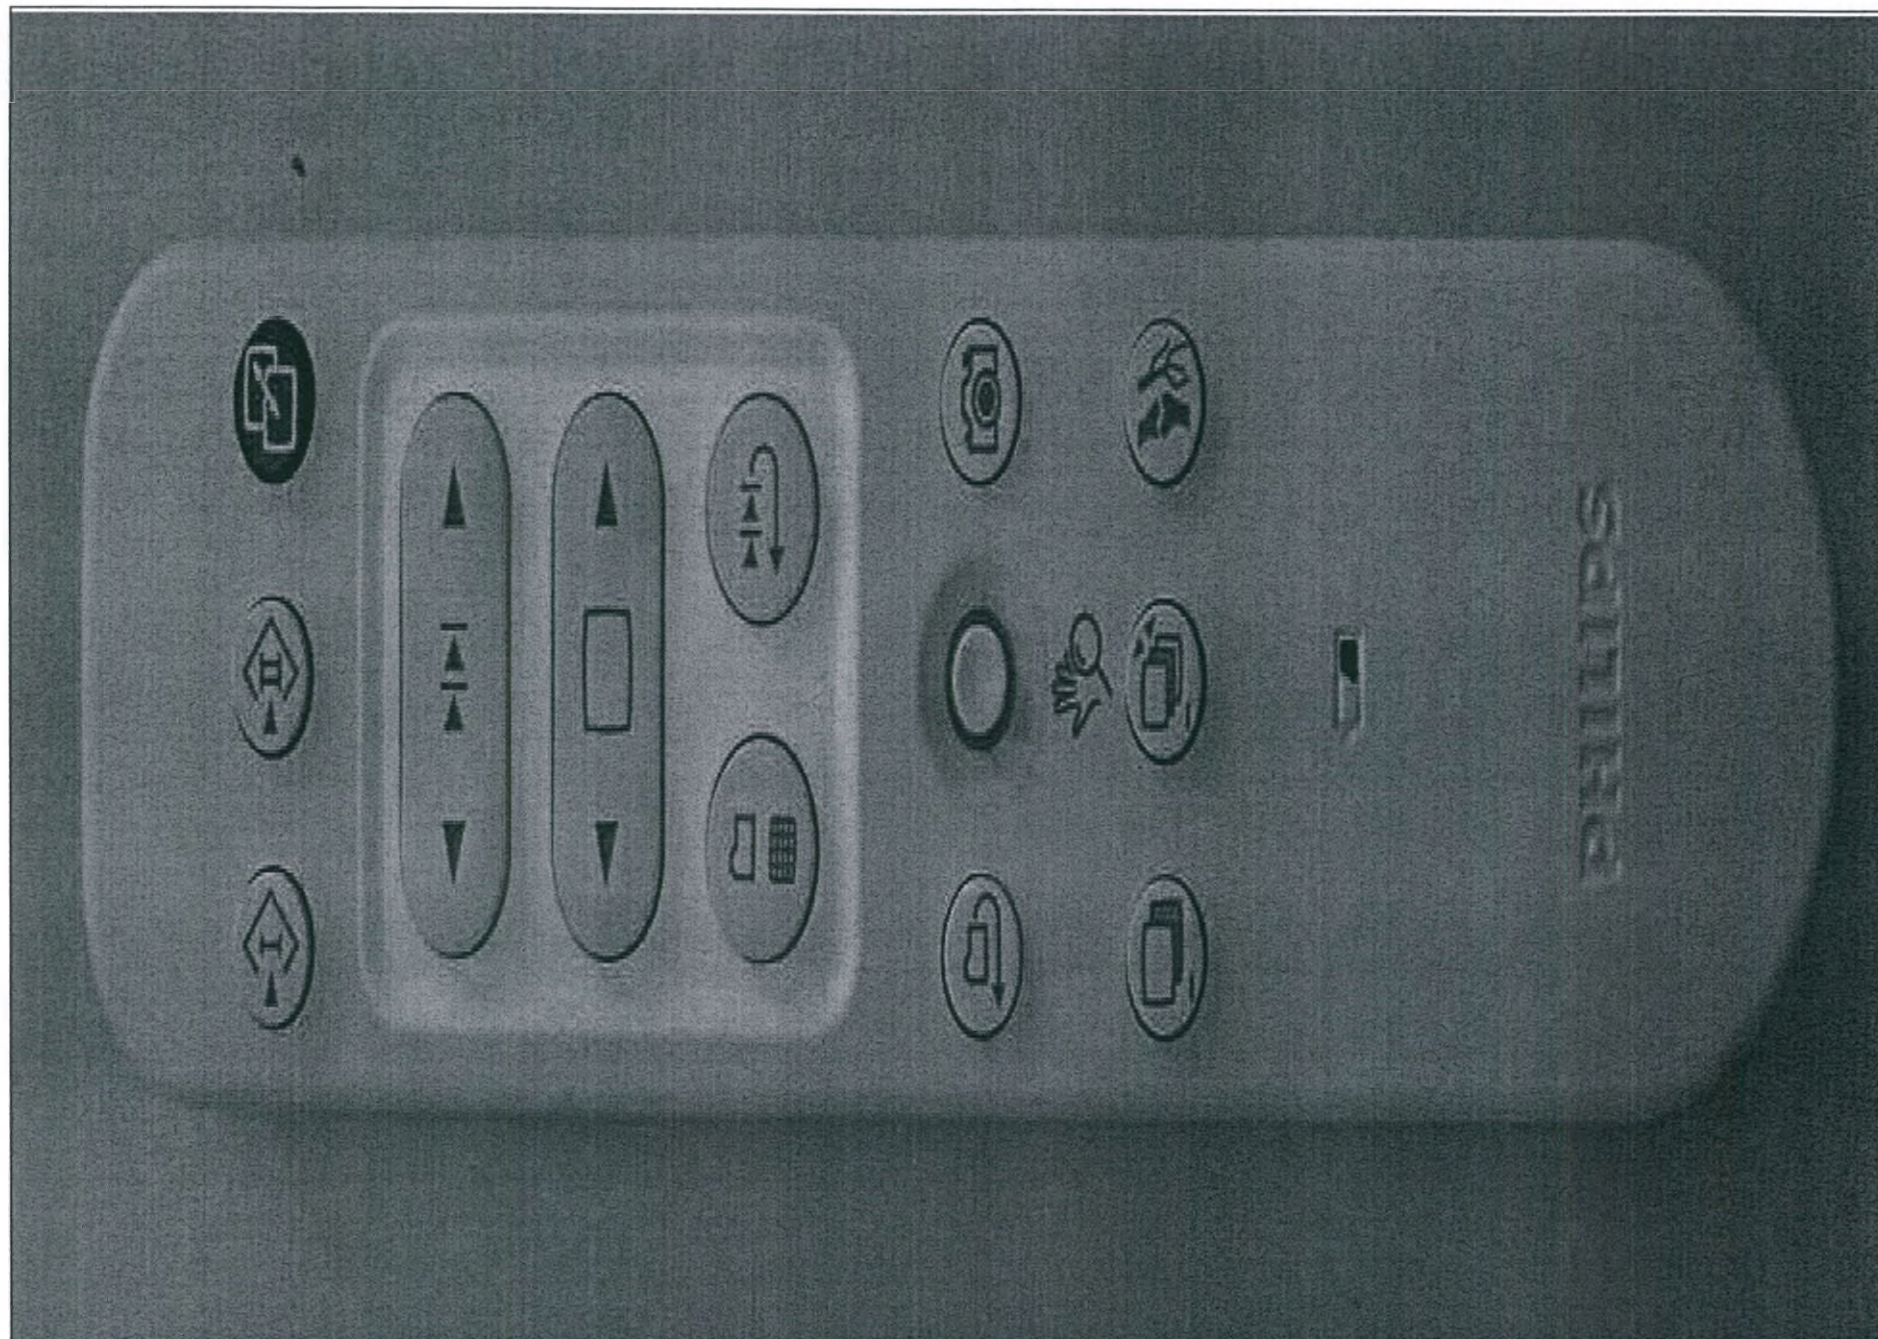


7. Пульт дистанционного управления для исследования сосудов.




8. Монохромный монитор для операционной с диагональю 19 дюймов

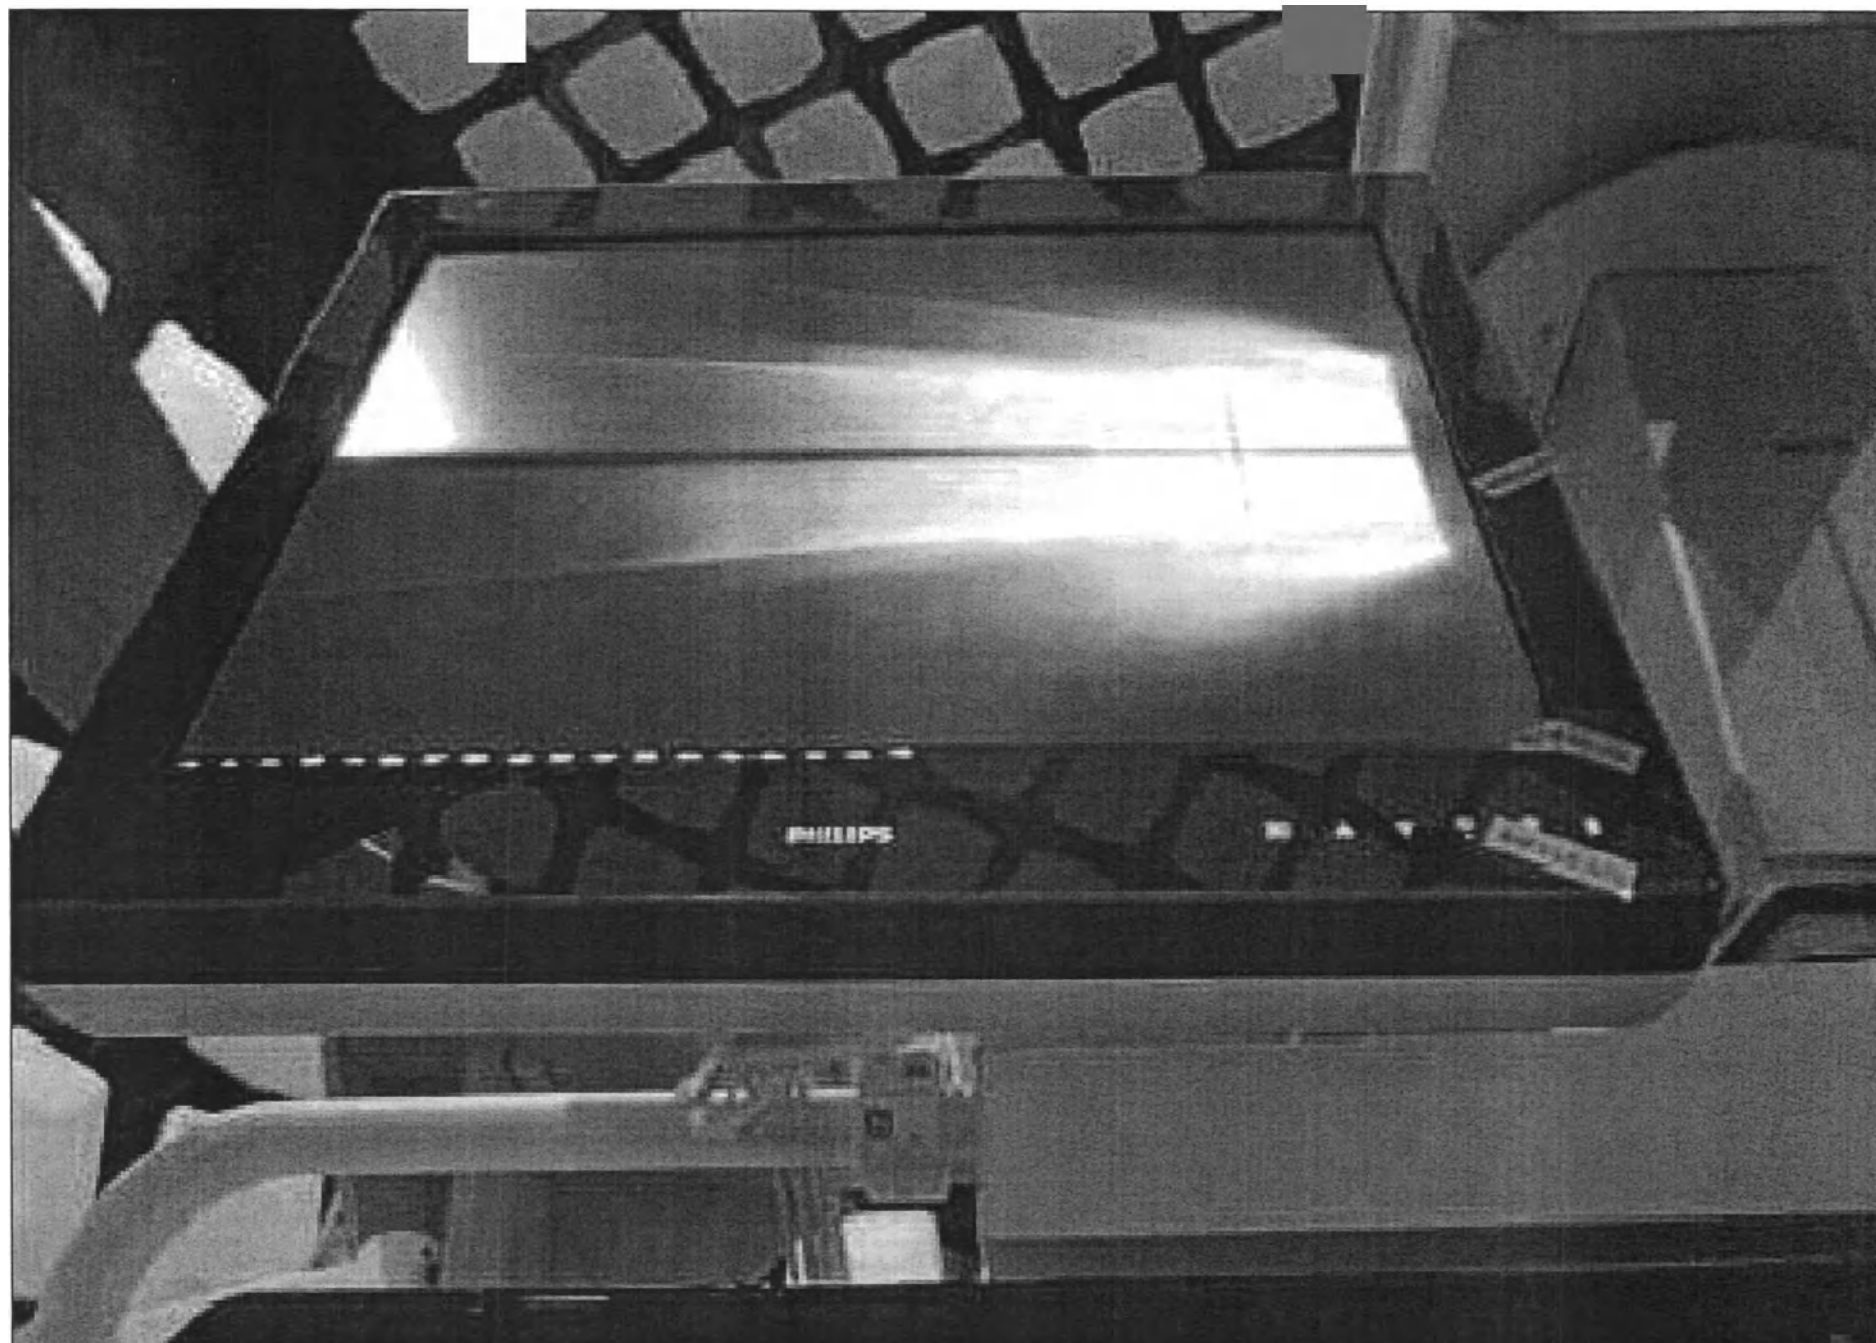


9. Цветной монитор для операционной с диагональю 19 дюймов.

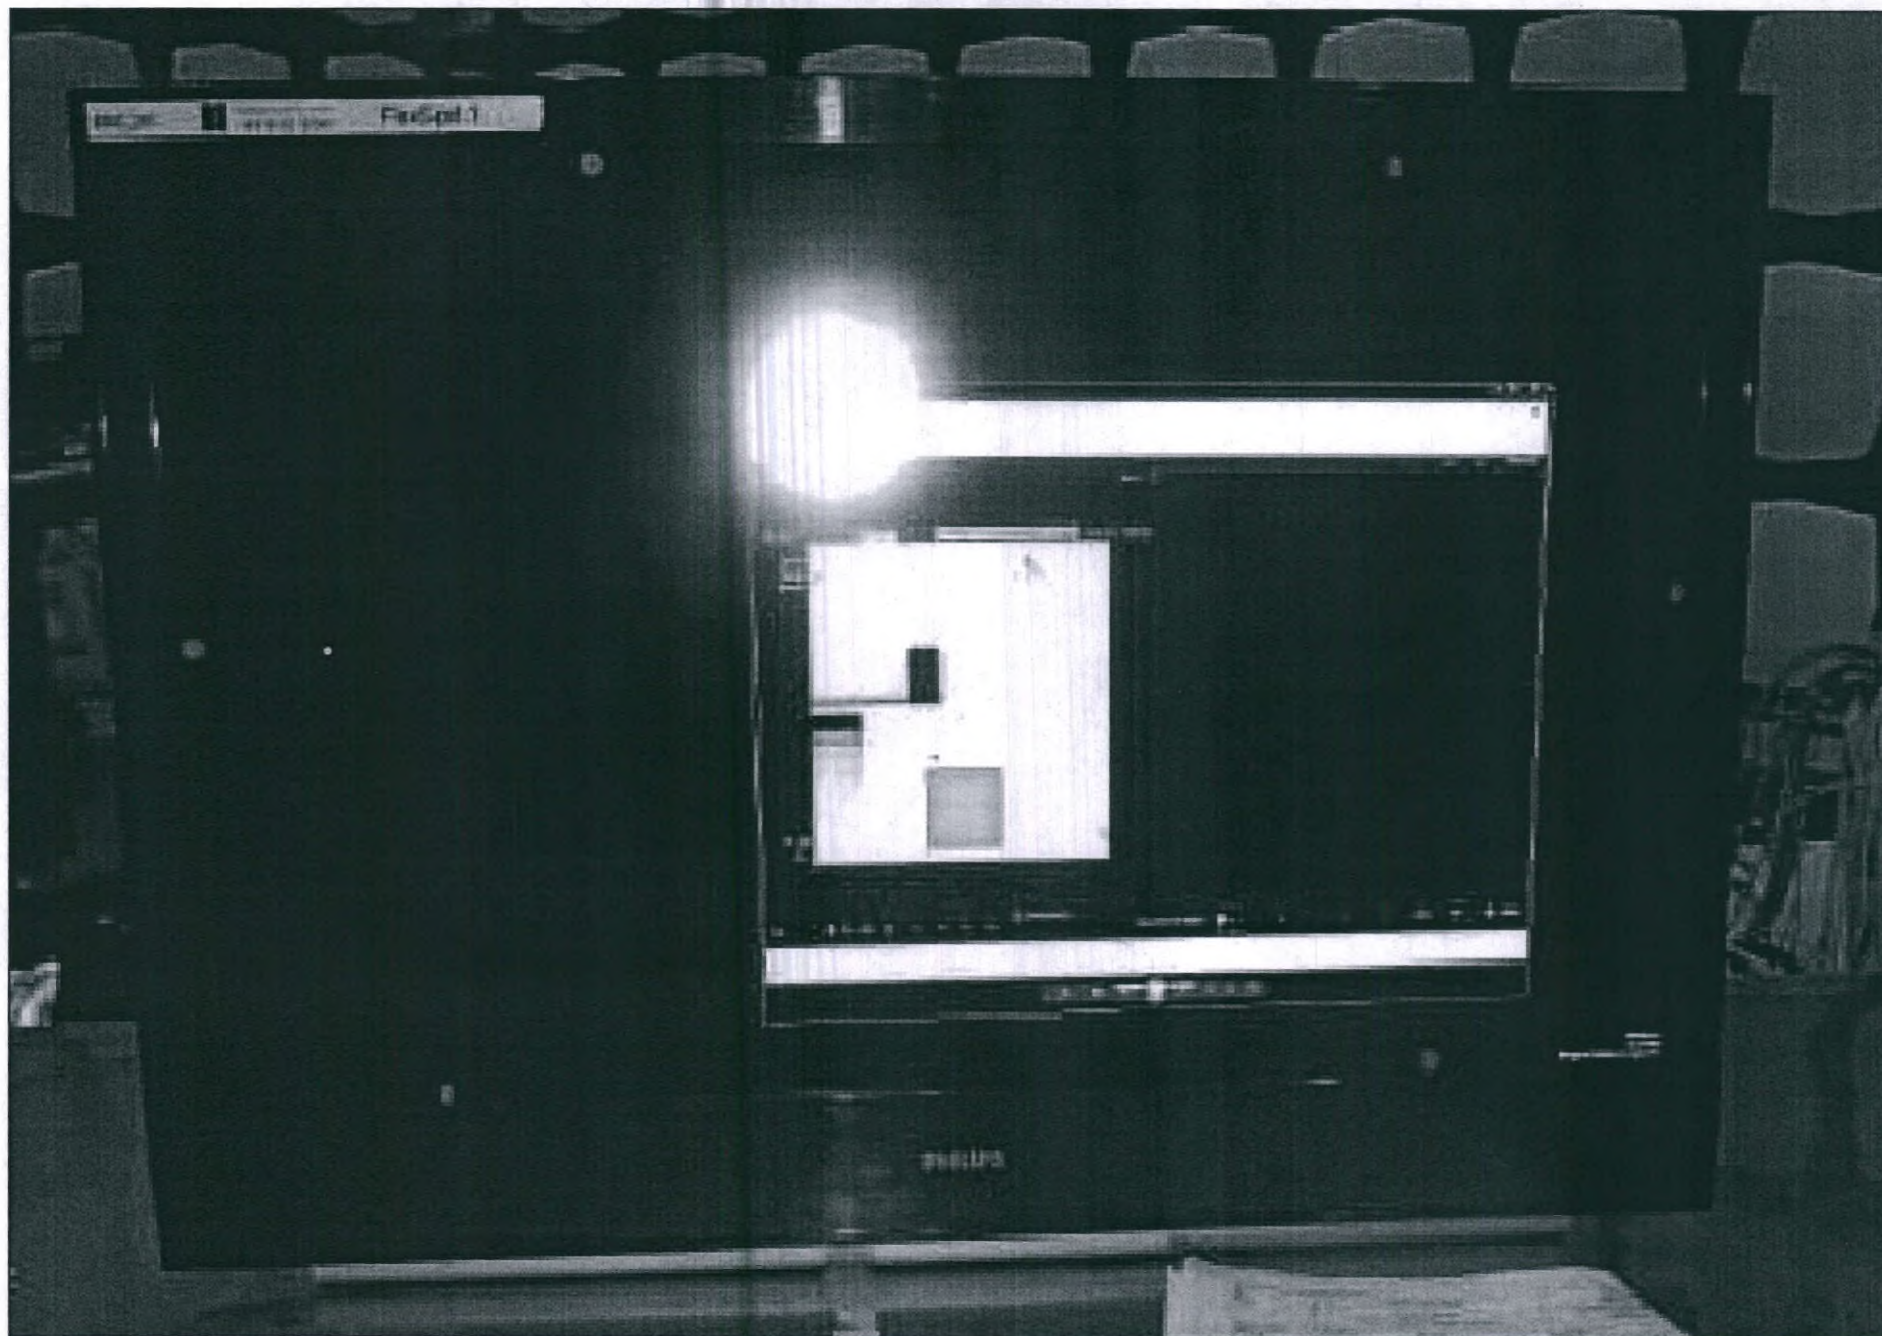


10. Цветной монитор для операционной с диагональю 27 дюймов.

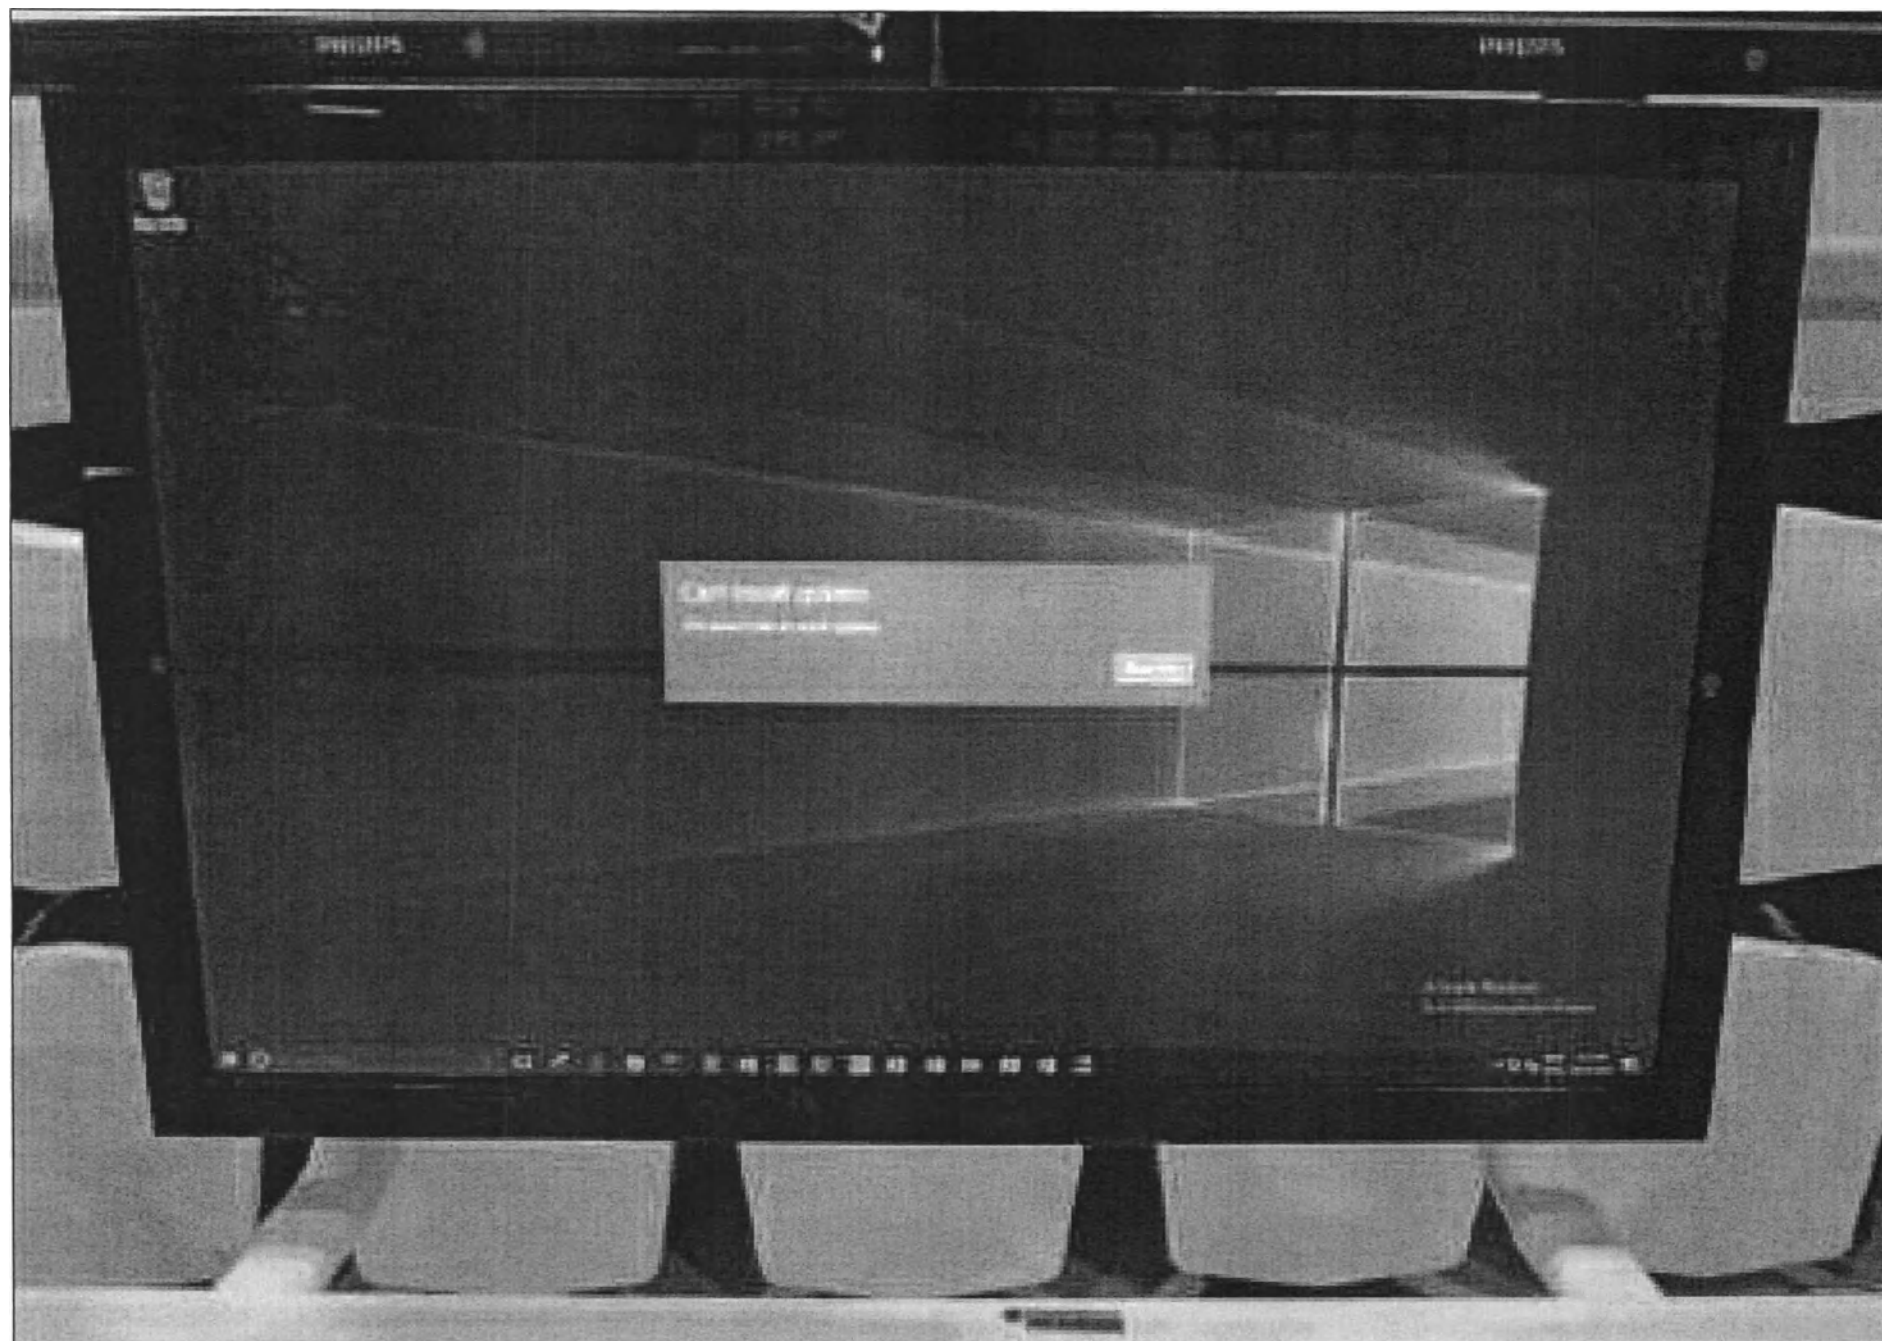


11. Цветной монитор для операционной с диагональю 32 дюйма.

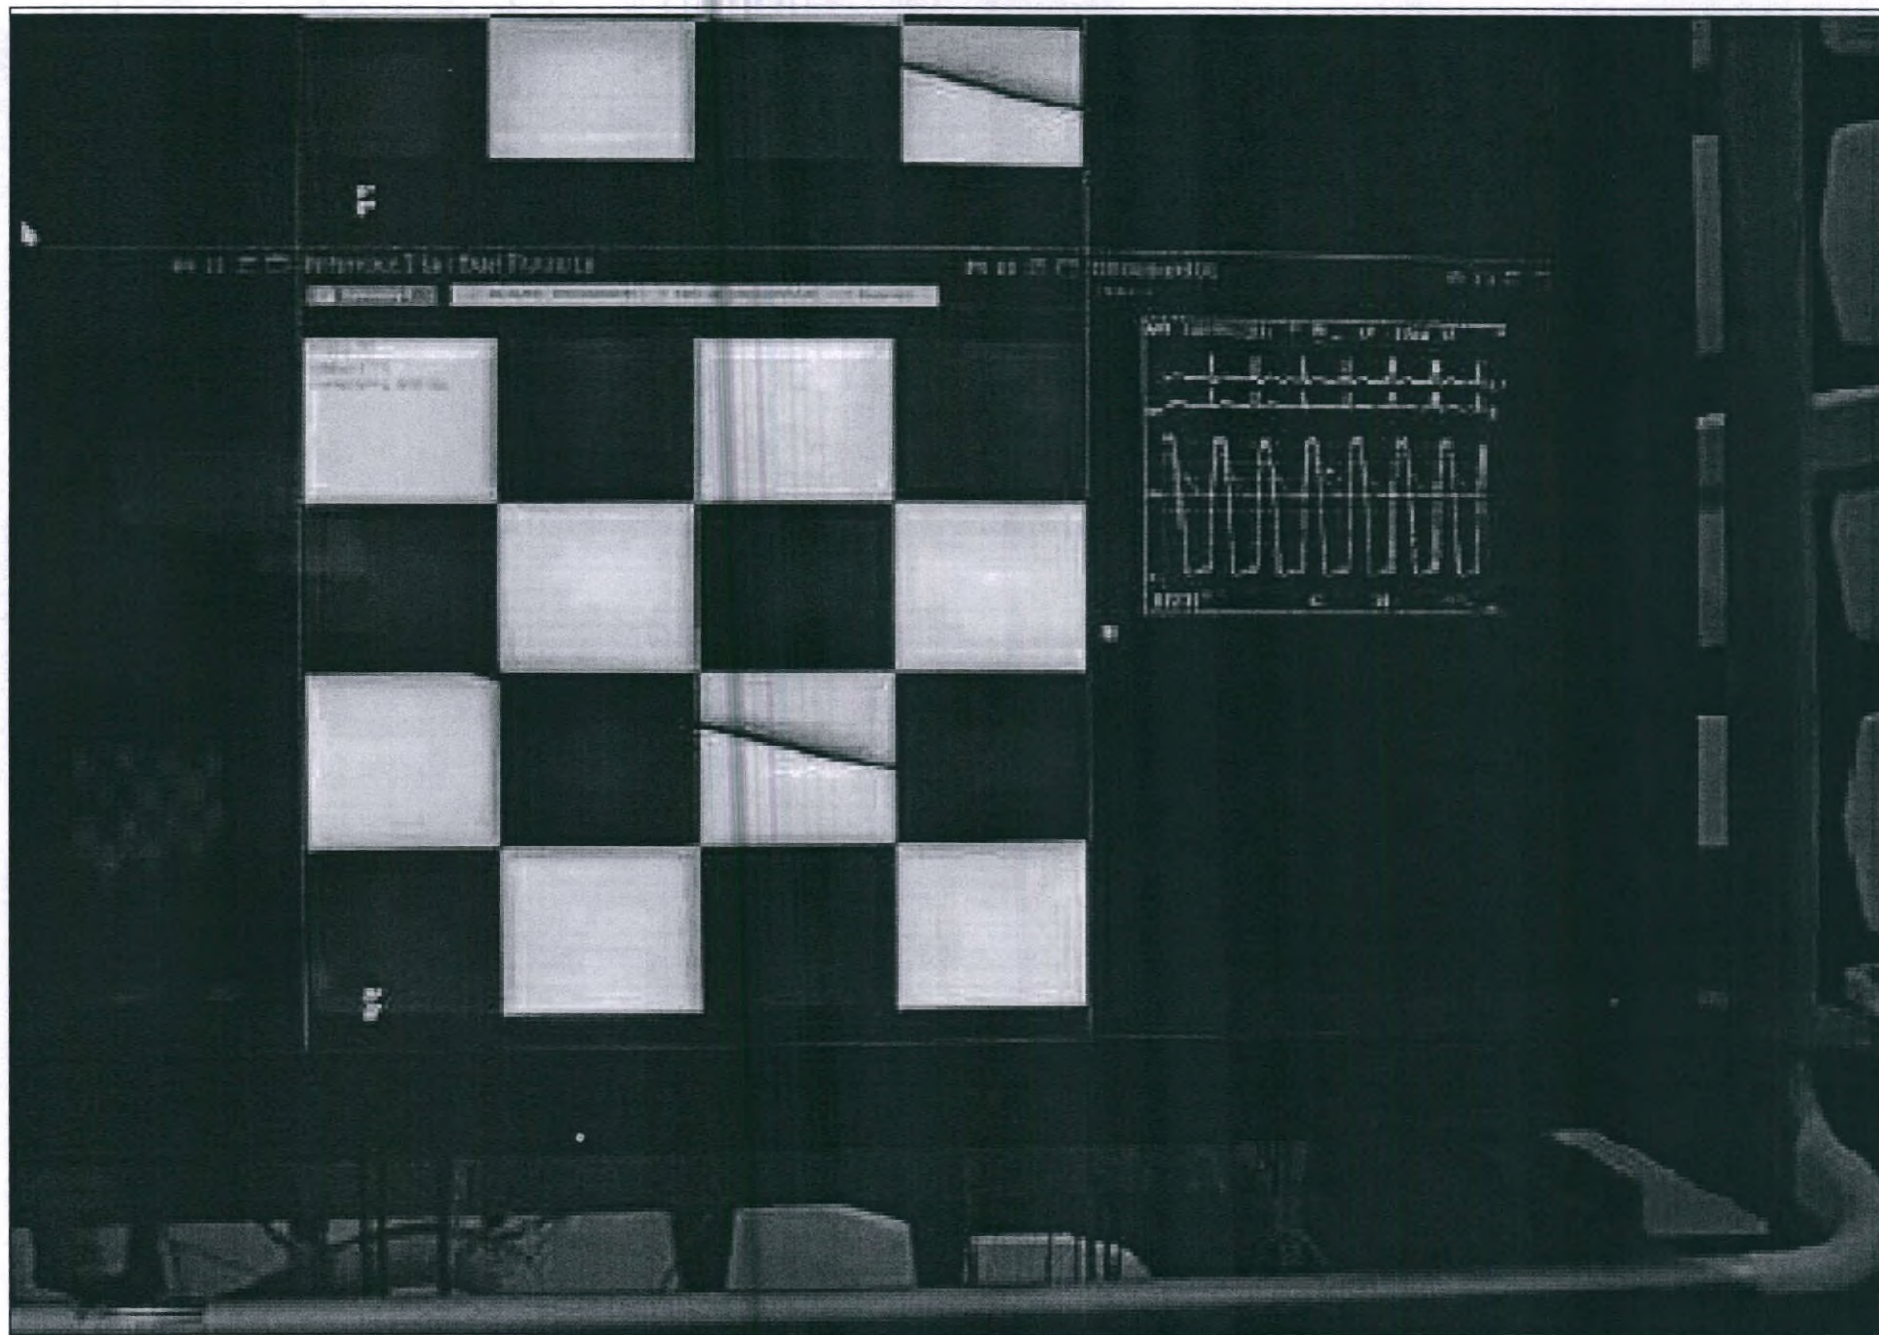

12.а. Большой цветной монитор для операционной с диагональю 58 дюймов.

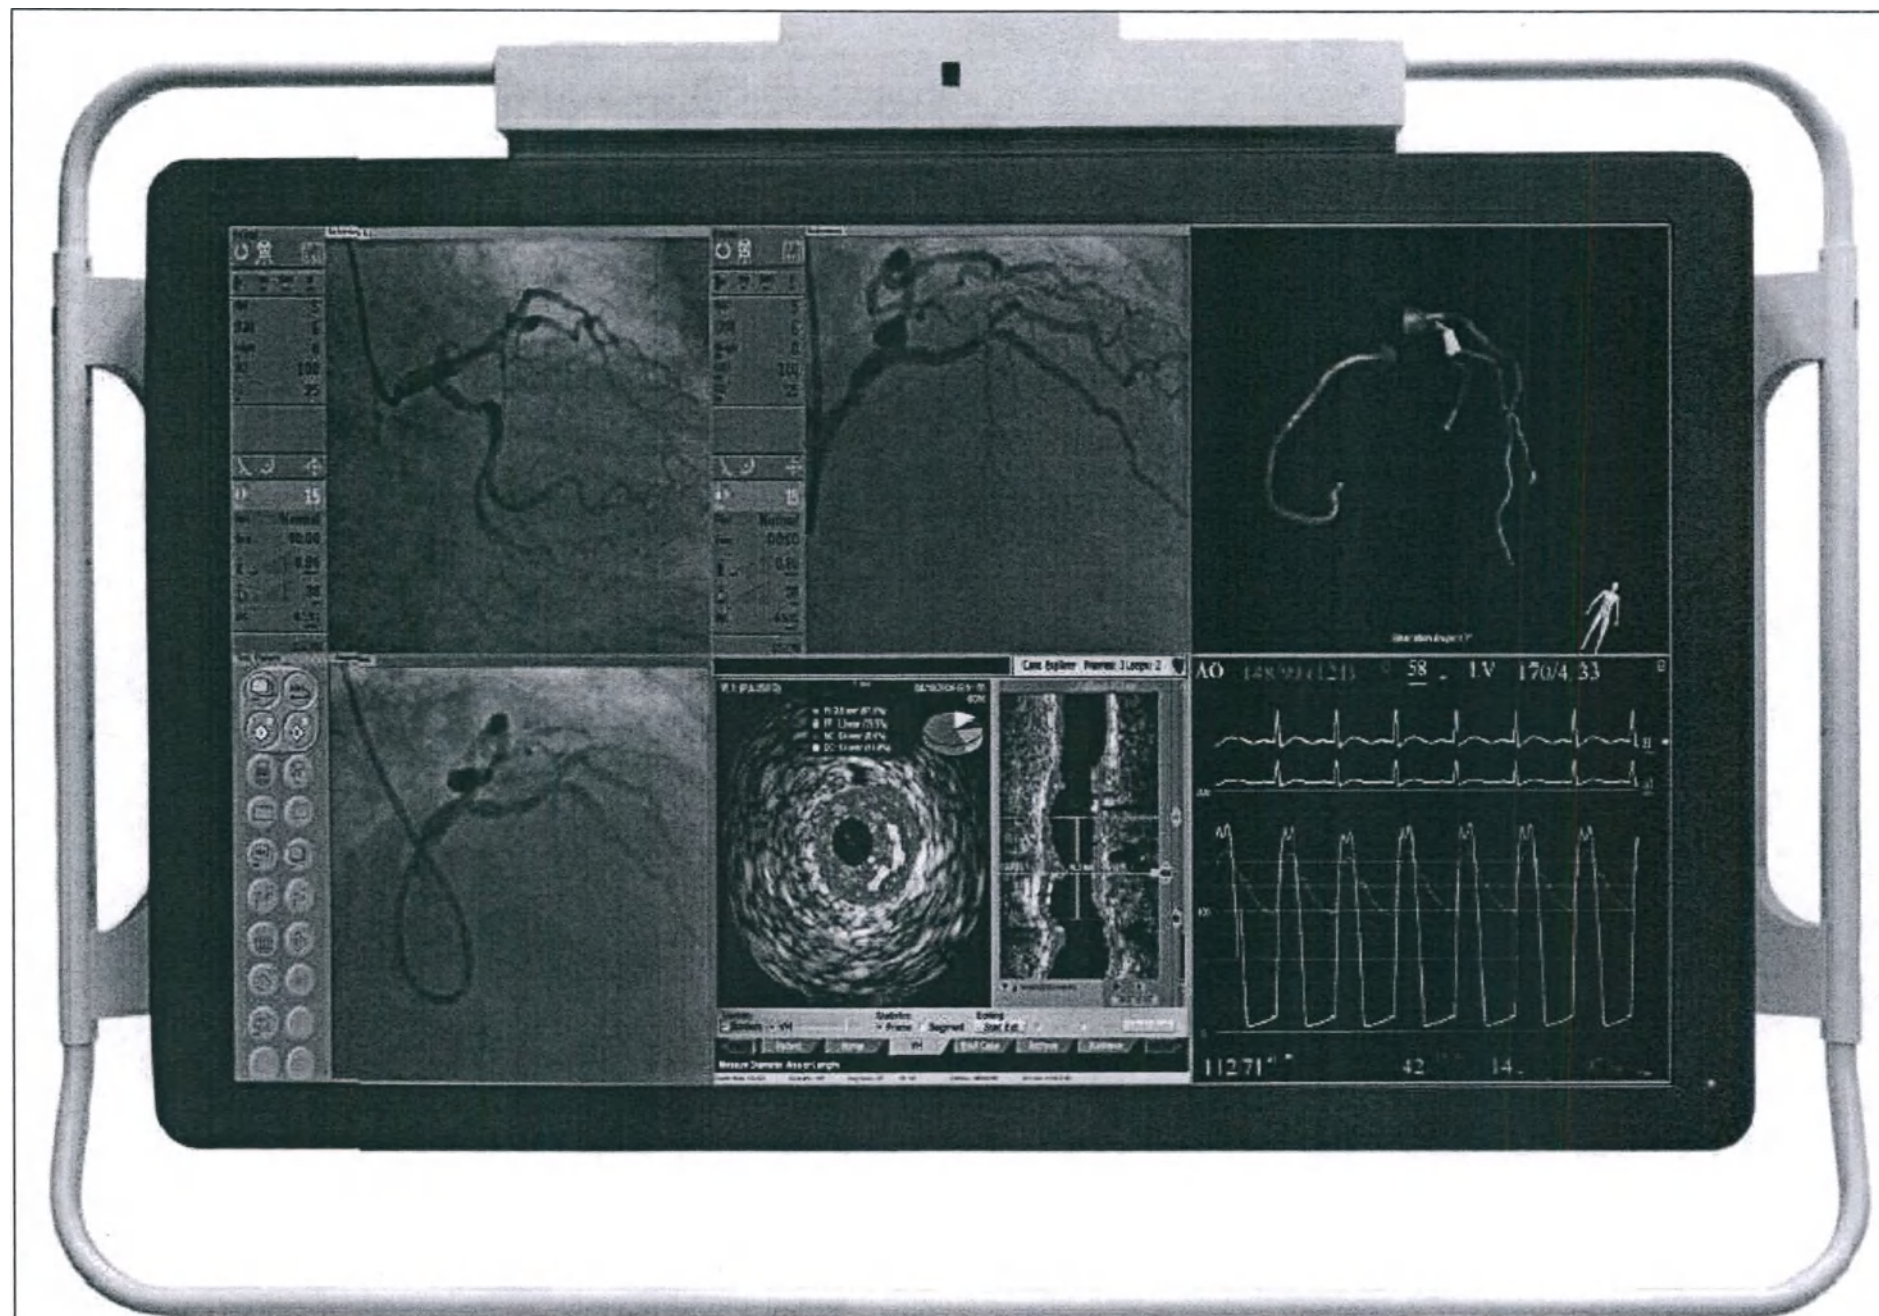


12.6. Большой цветной монитор для операционной с диагональю 58 дюймов.

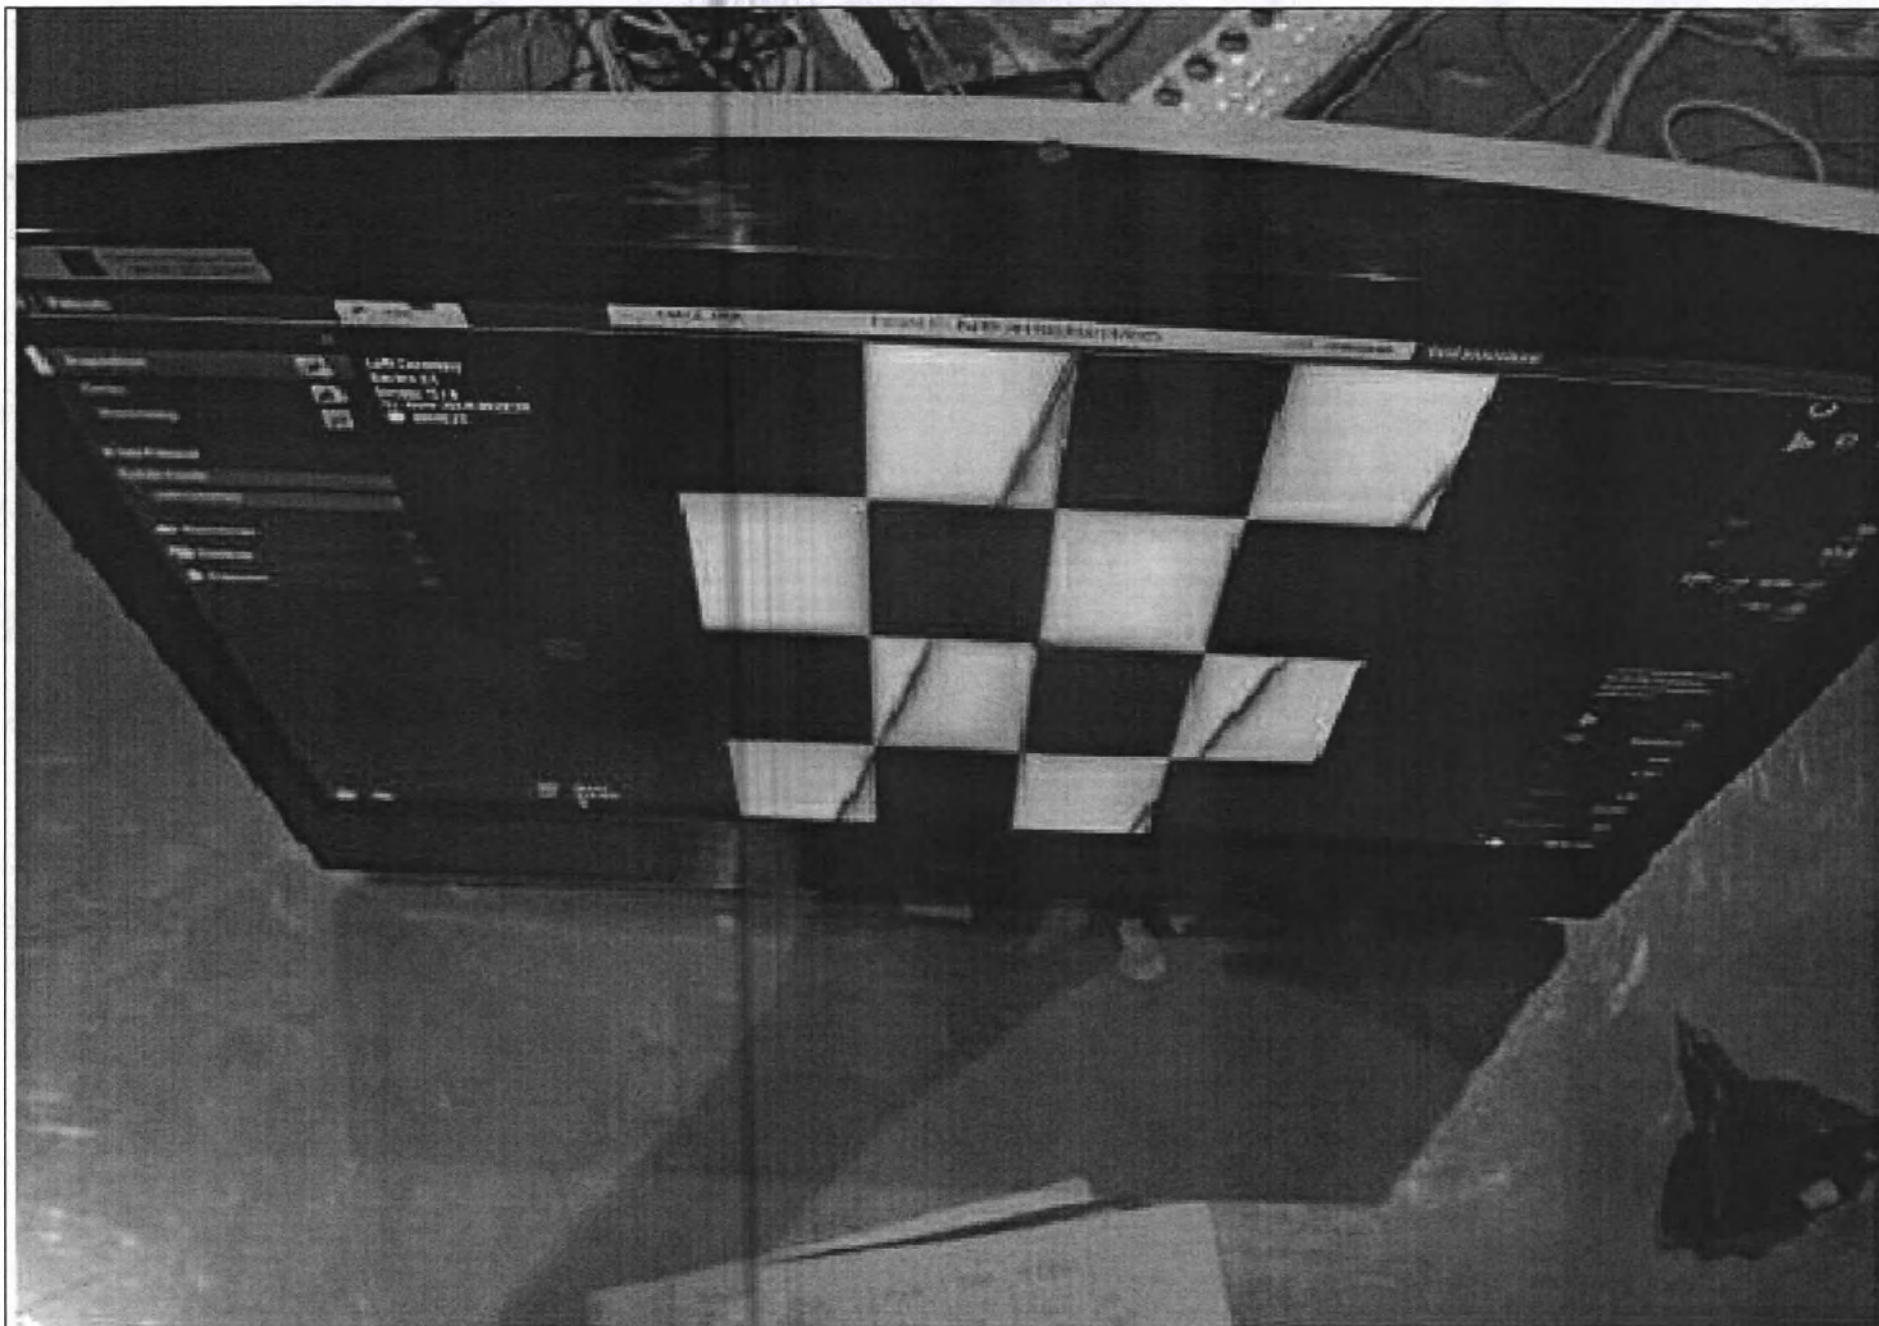


13.а. Цветной монитор для пультовой с диагональю 24 дюйма.




13.6. Цветной монитор для пультавой с диагональю 24 дюйма.

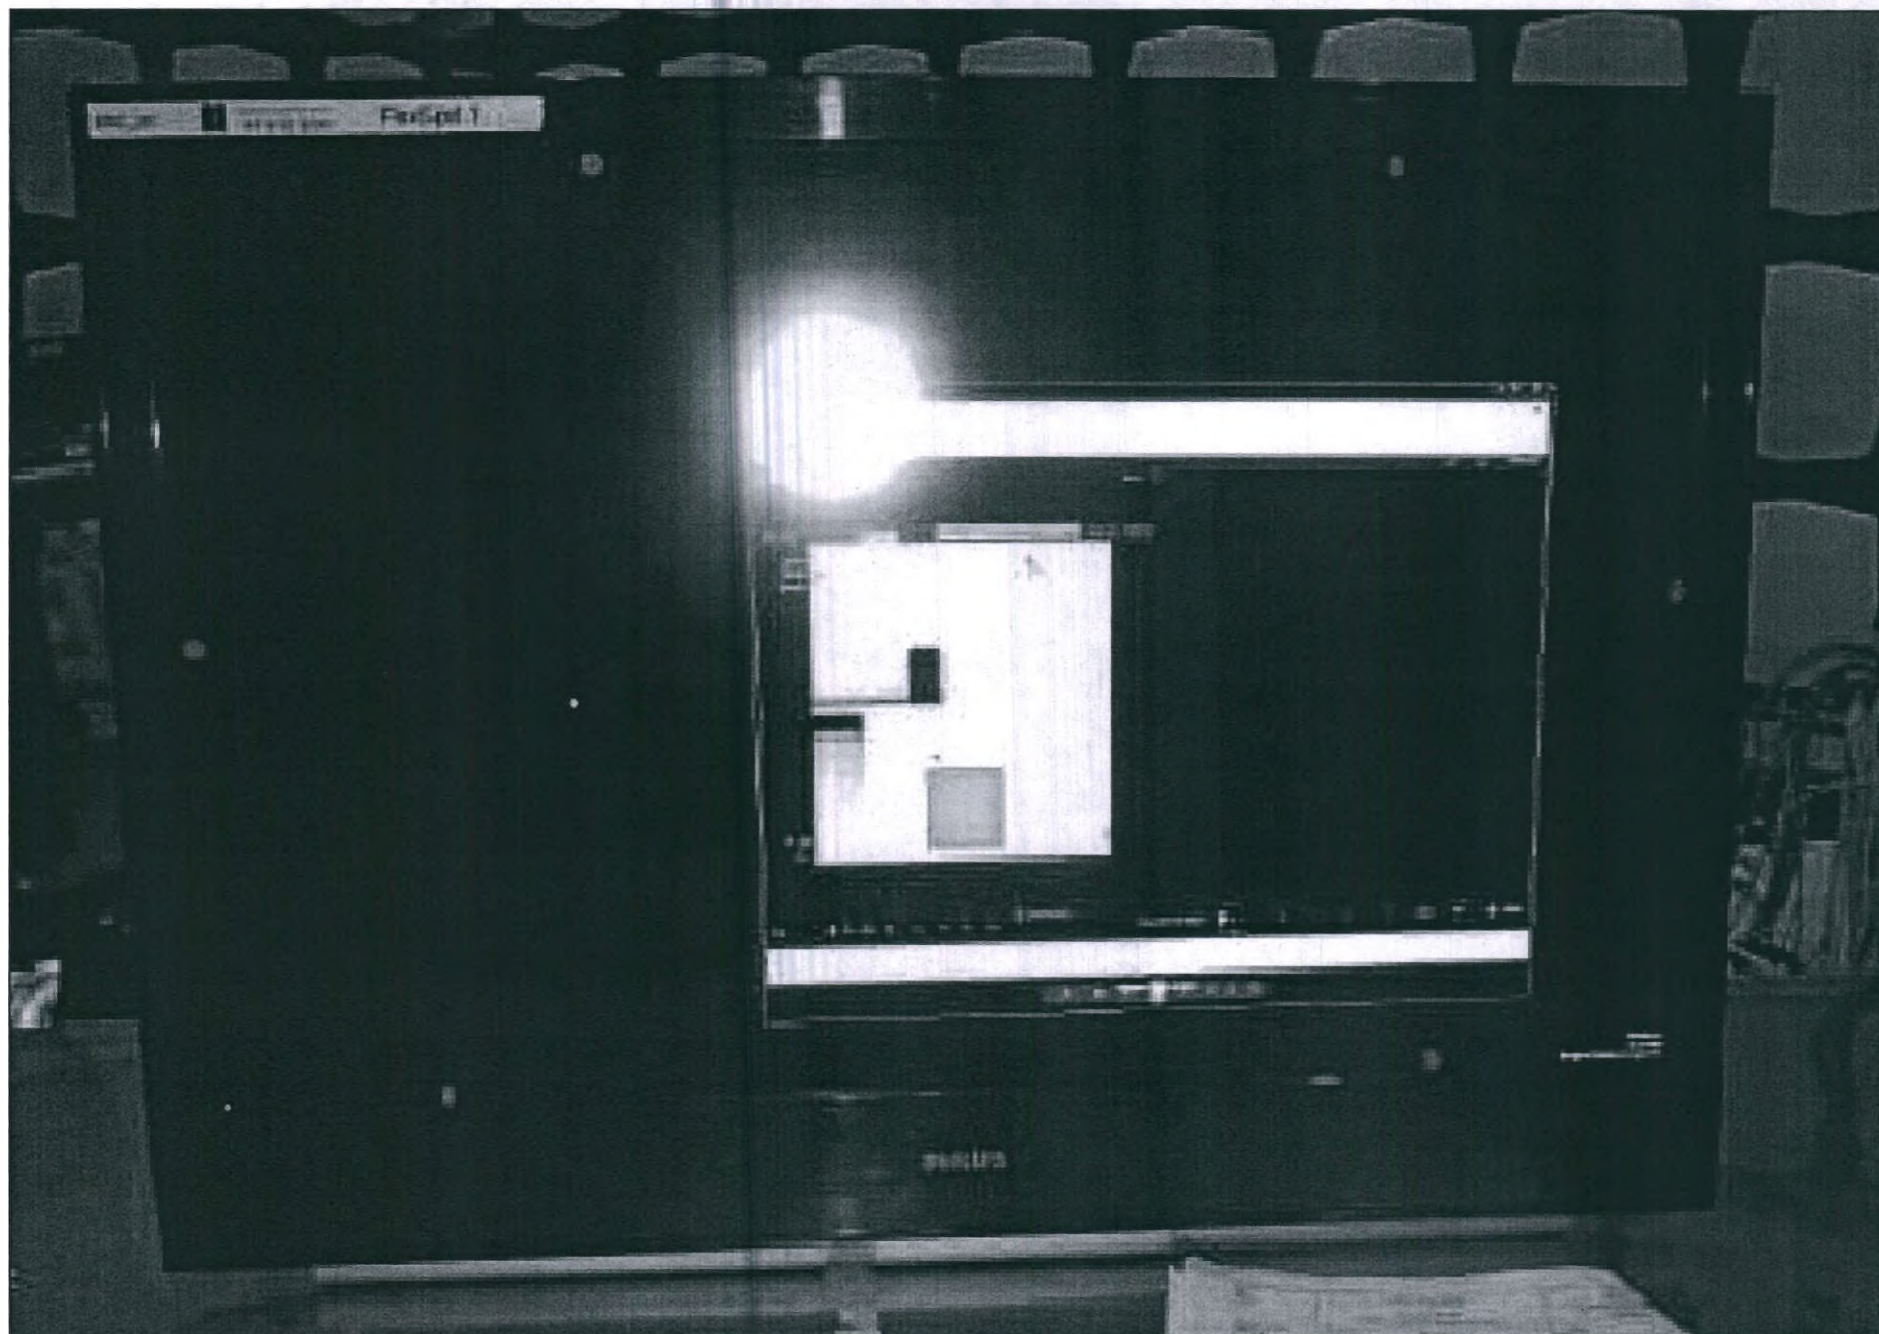


14. Цветной монитор для пультовой с диагональю 27 дюймов

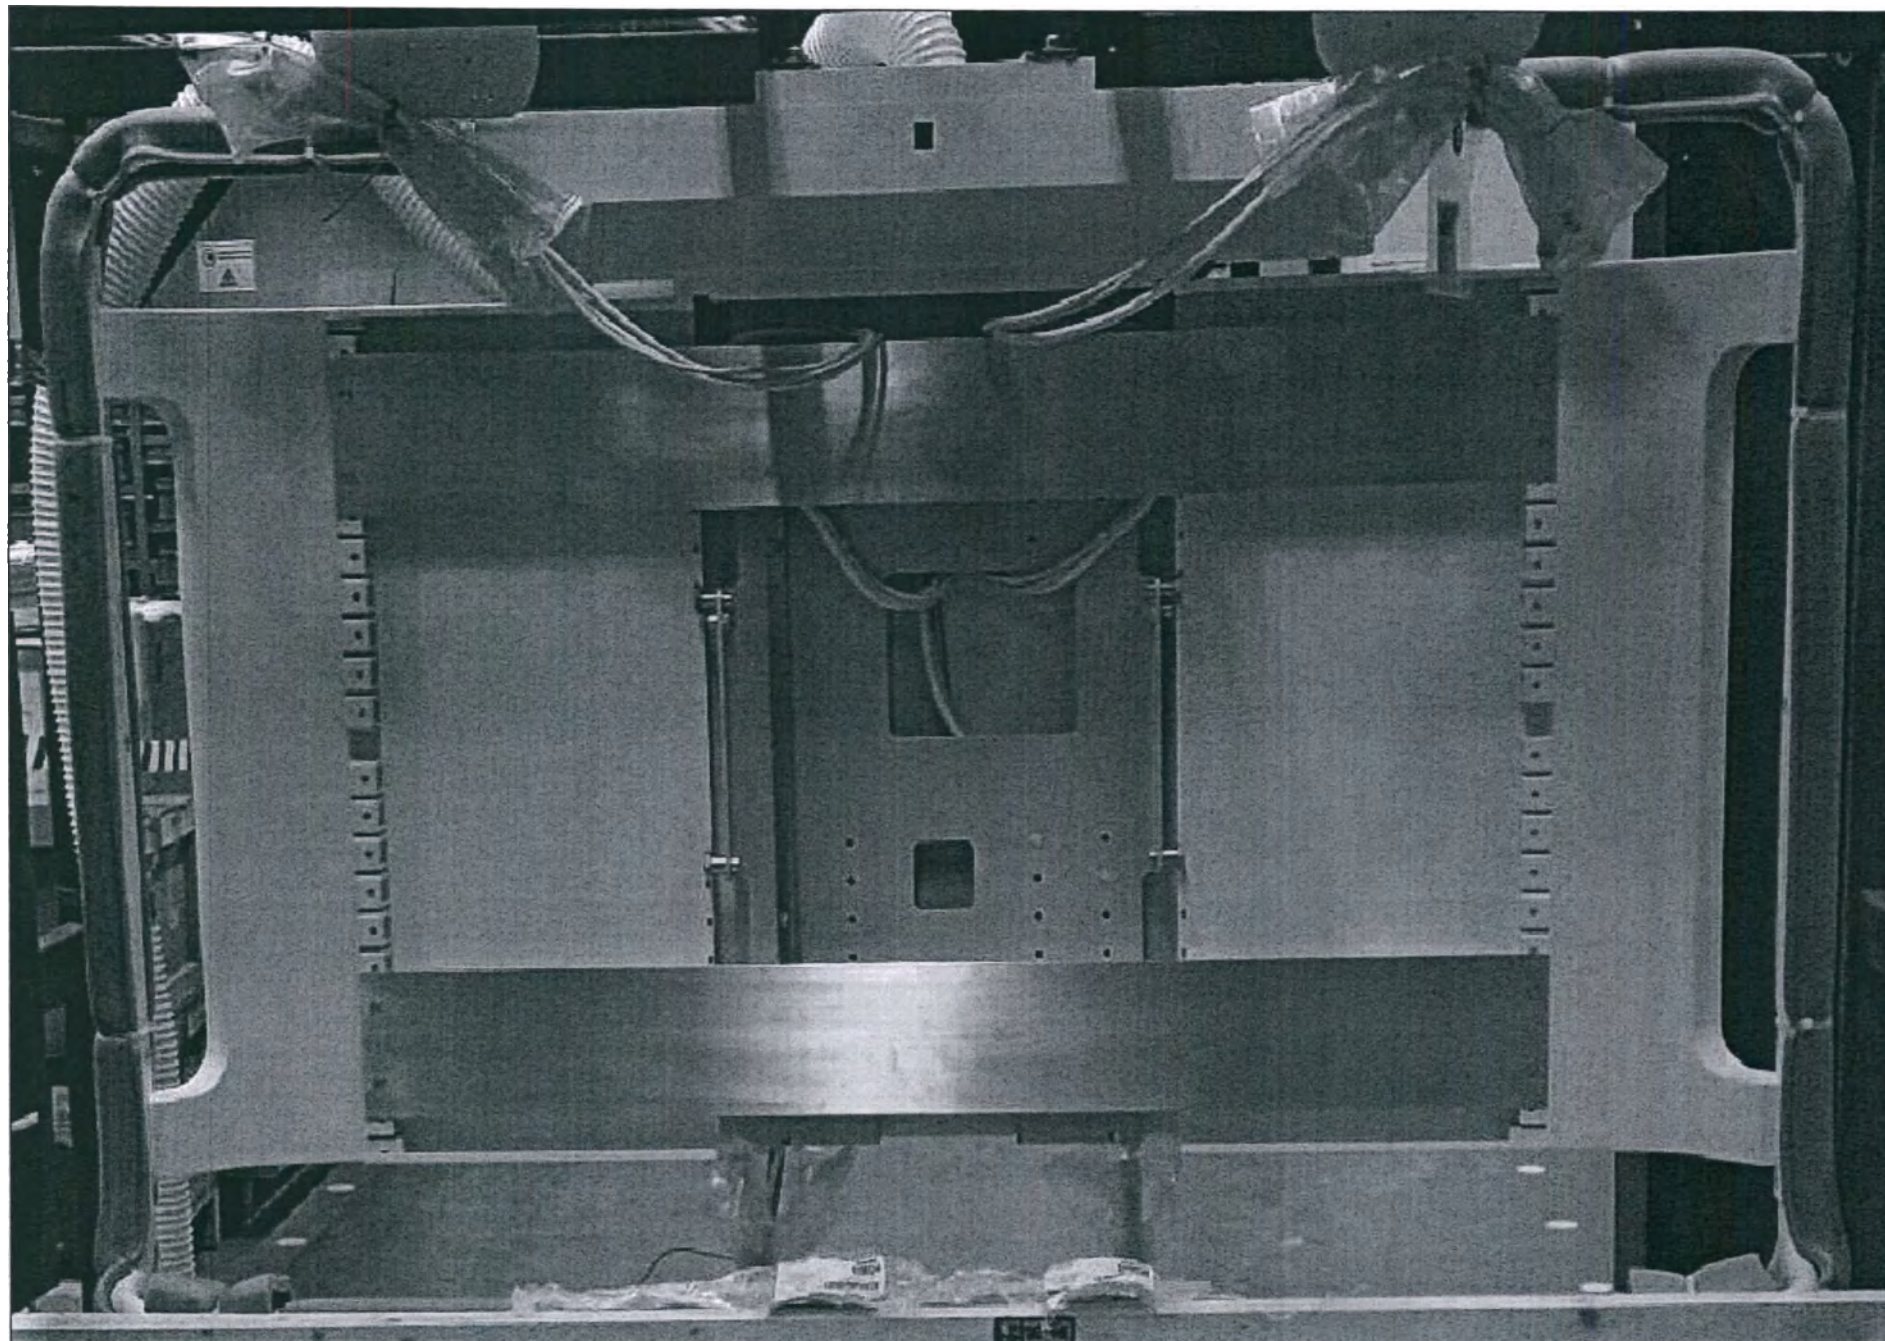


15.а. Потолочный подвес для мониторов: 2-секционный, 4-секционный, 6-секционный.

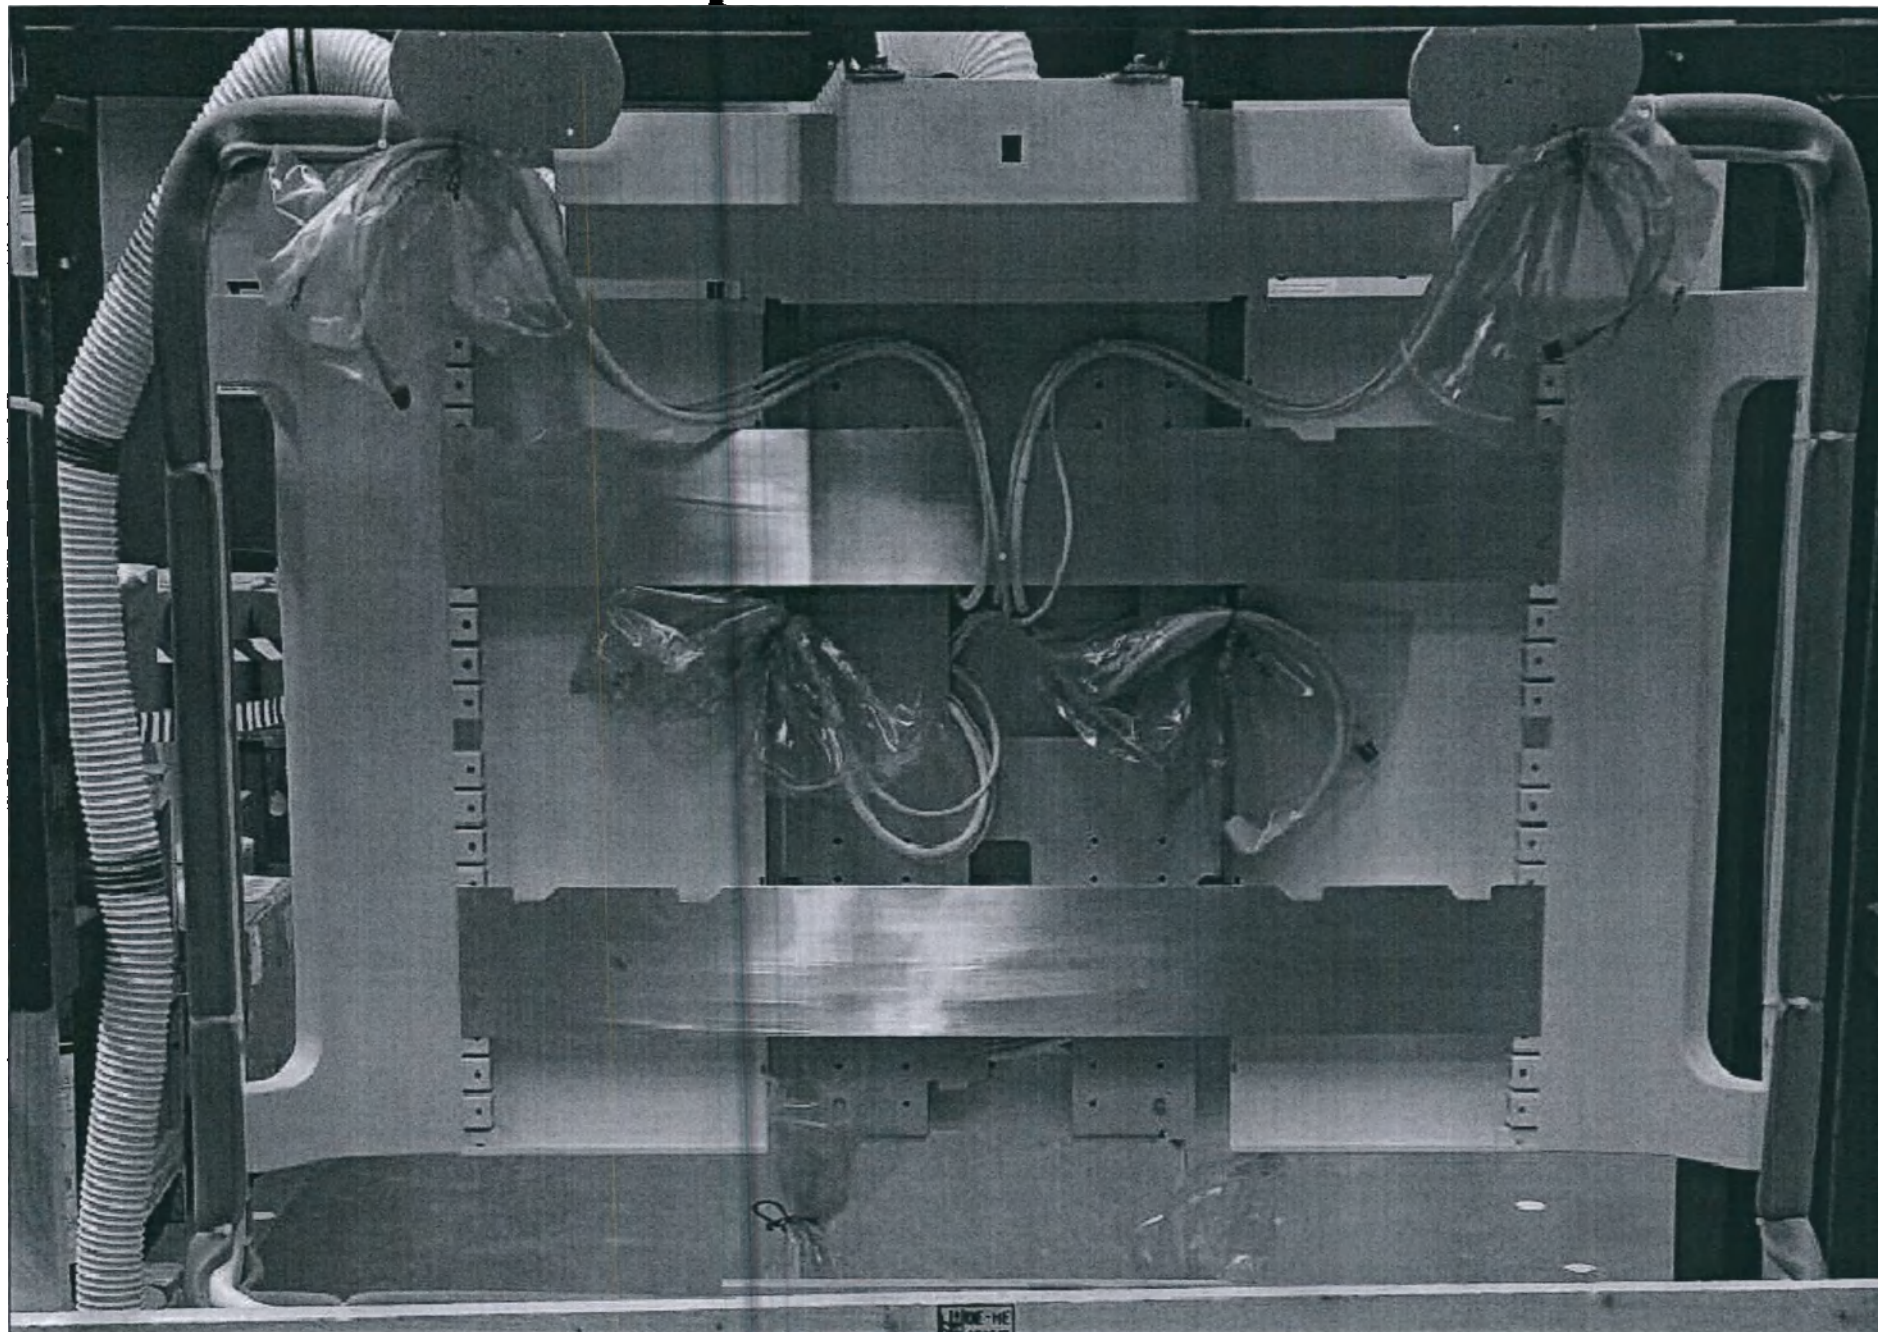


15.6. Потолочный подвес для мониторов: 2-секционный, 4-секционный, 6-секционный.

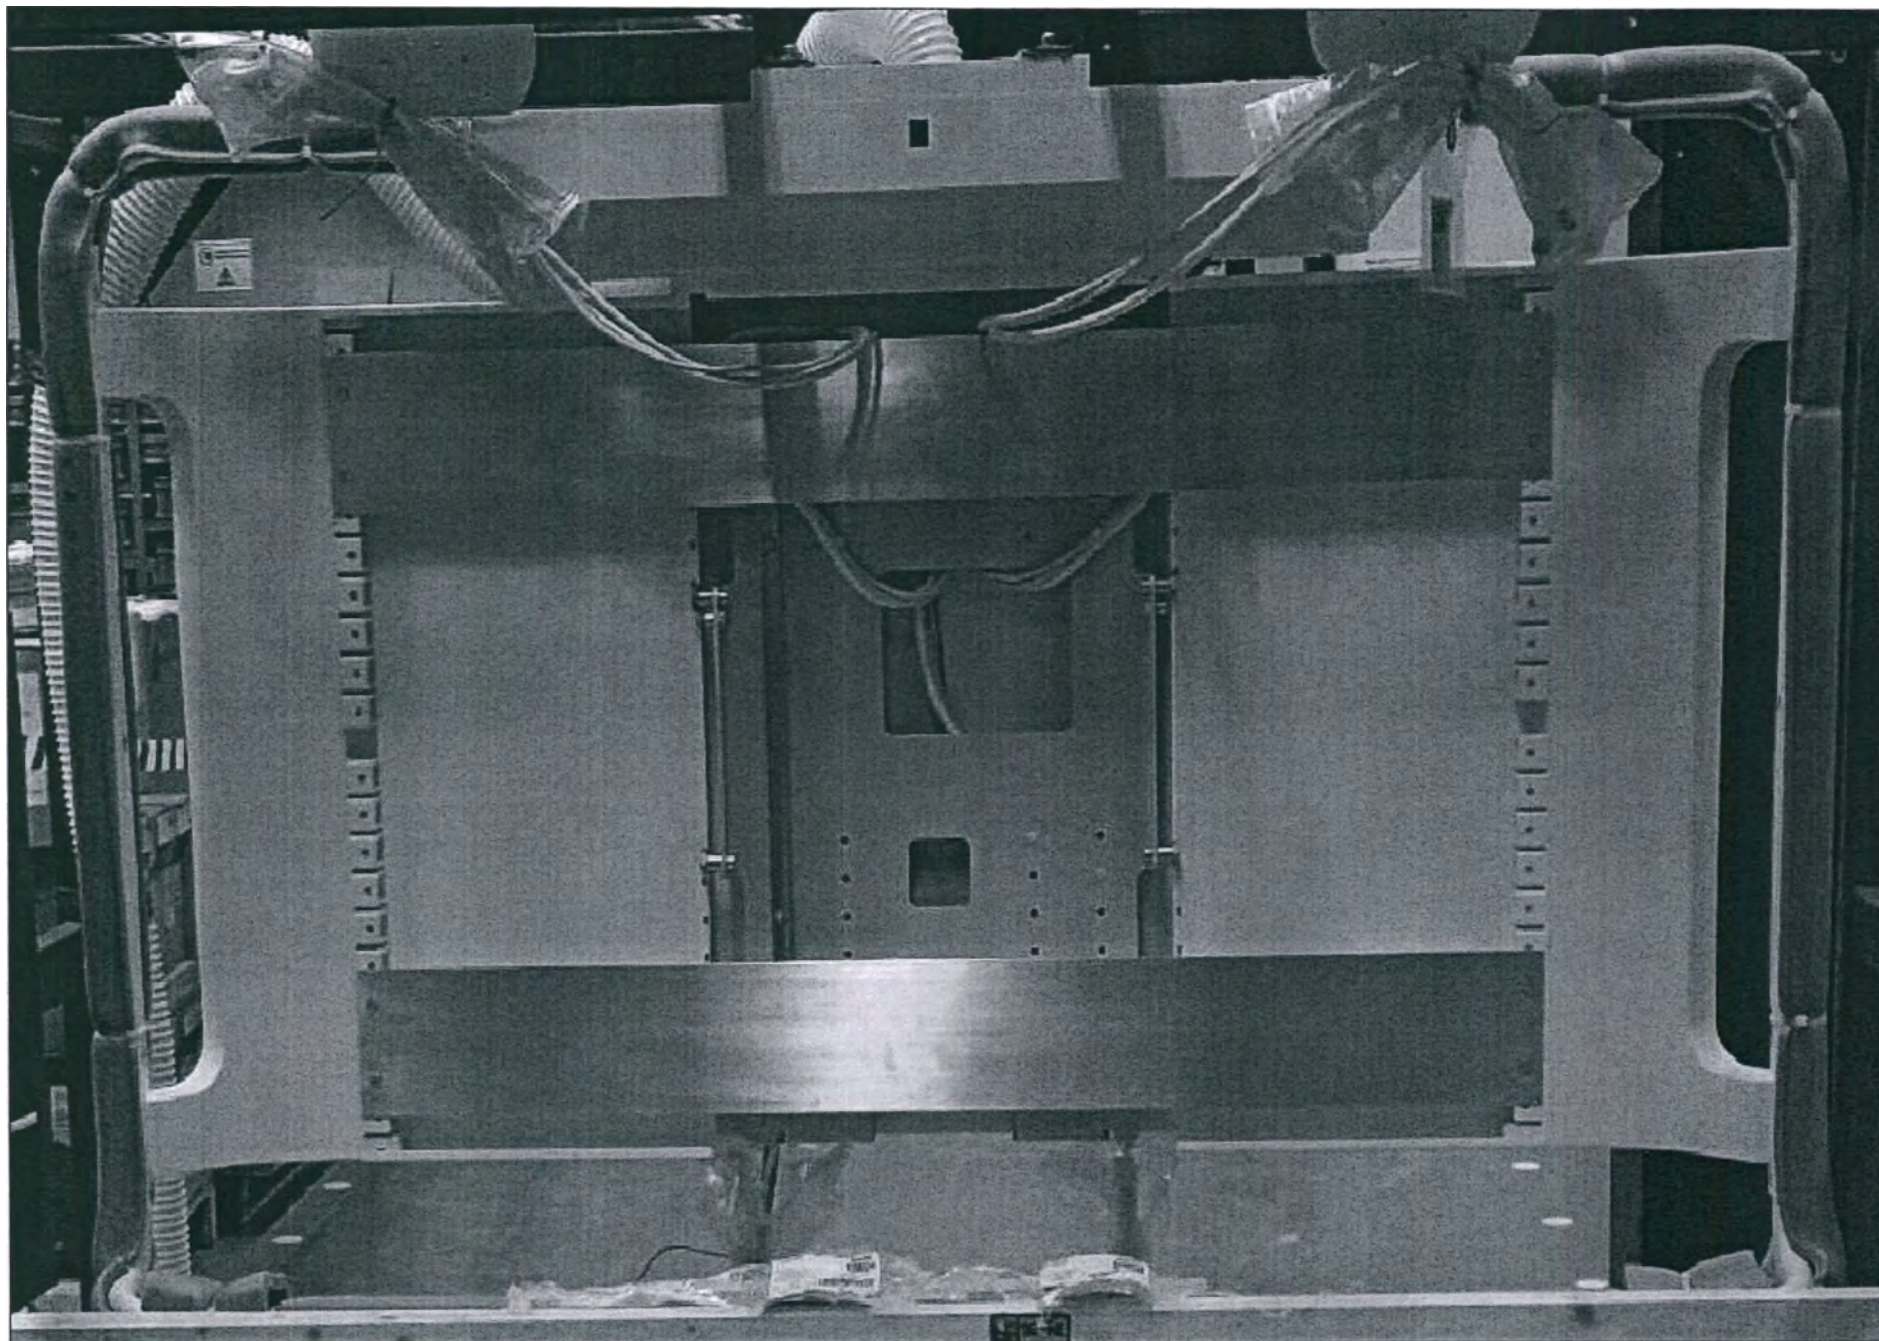


16. Потолочный подвес для большого цветного монитора 58 дюймов: 1-секционный, 3-секционный

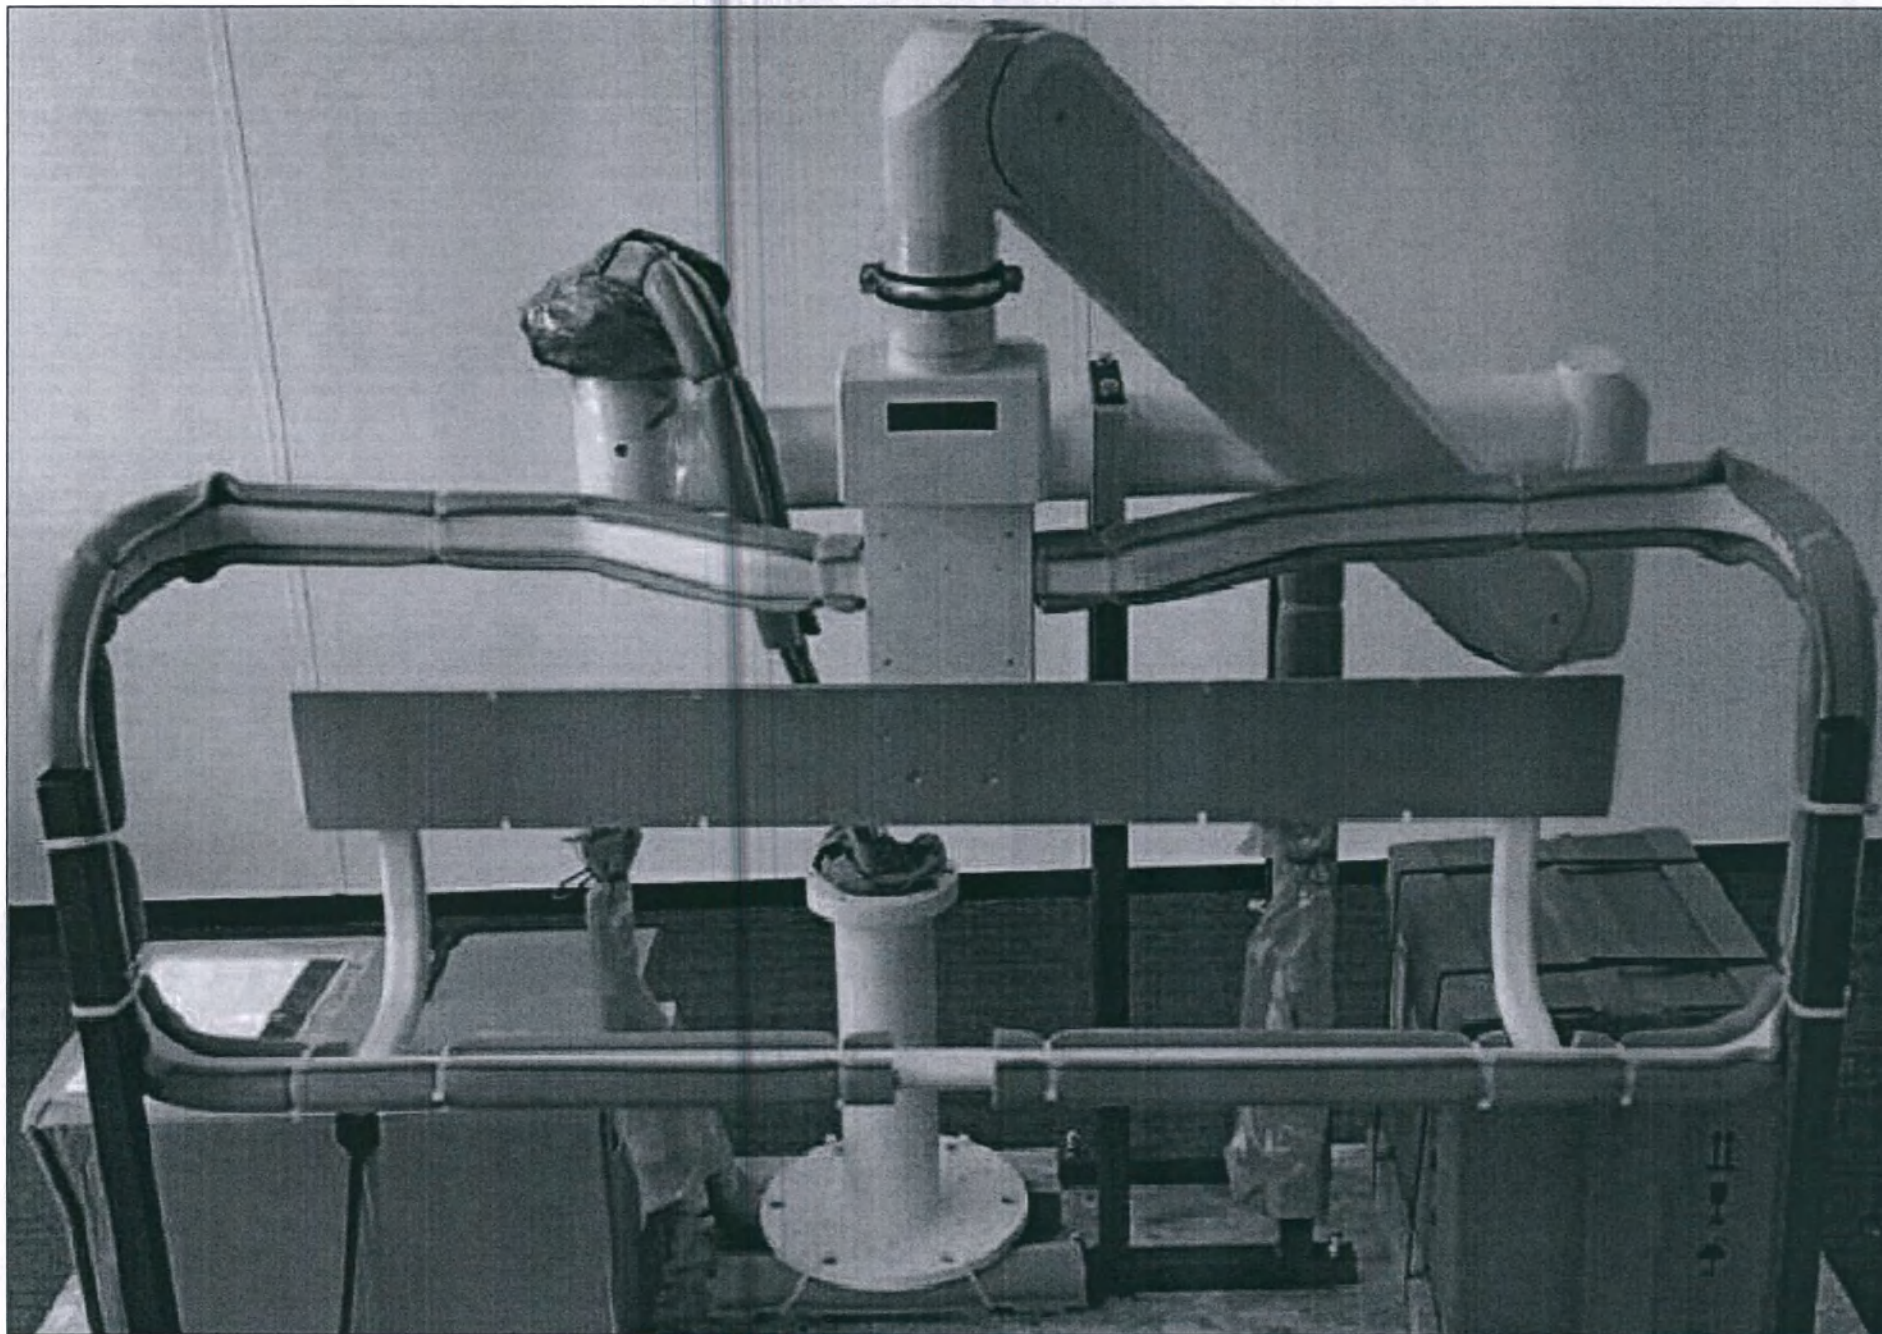

17.а. Потолочный подвес для мониторов с подпружиненным кронштейном: 2-секционный. 3-секционный.

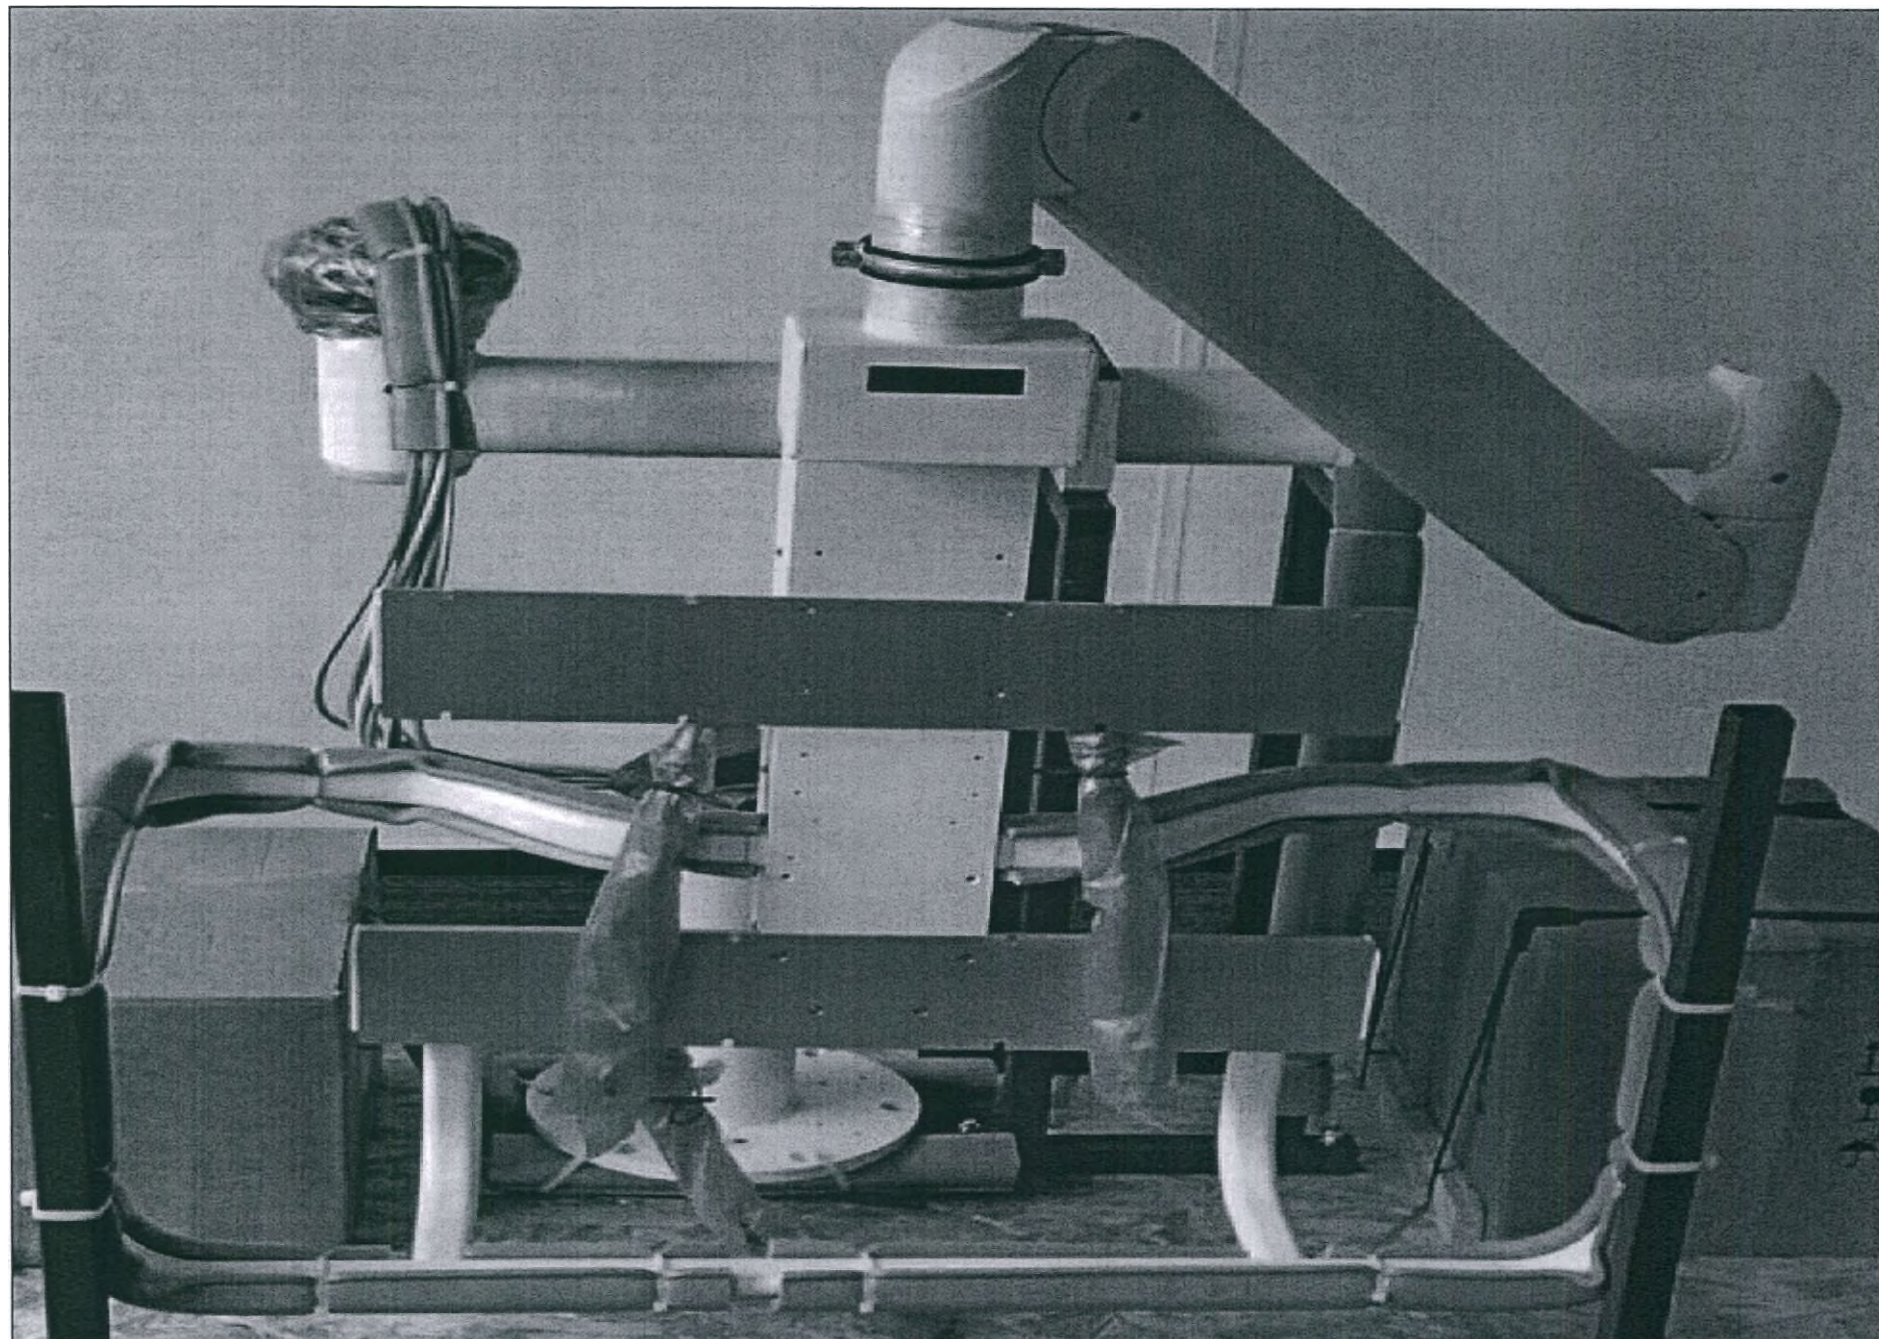

17.6. Потолочный подвес для мониторов с подпружиненным кронштейном: 2-секционный. 3-секционный.

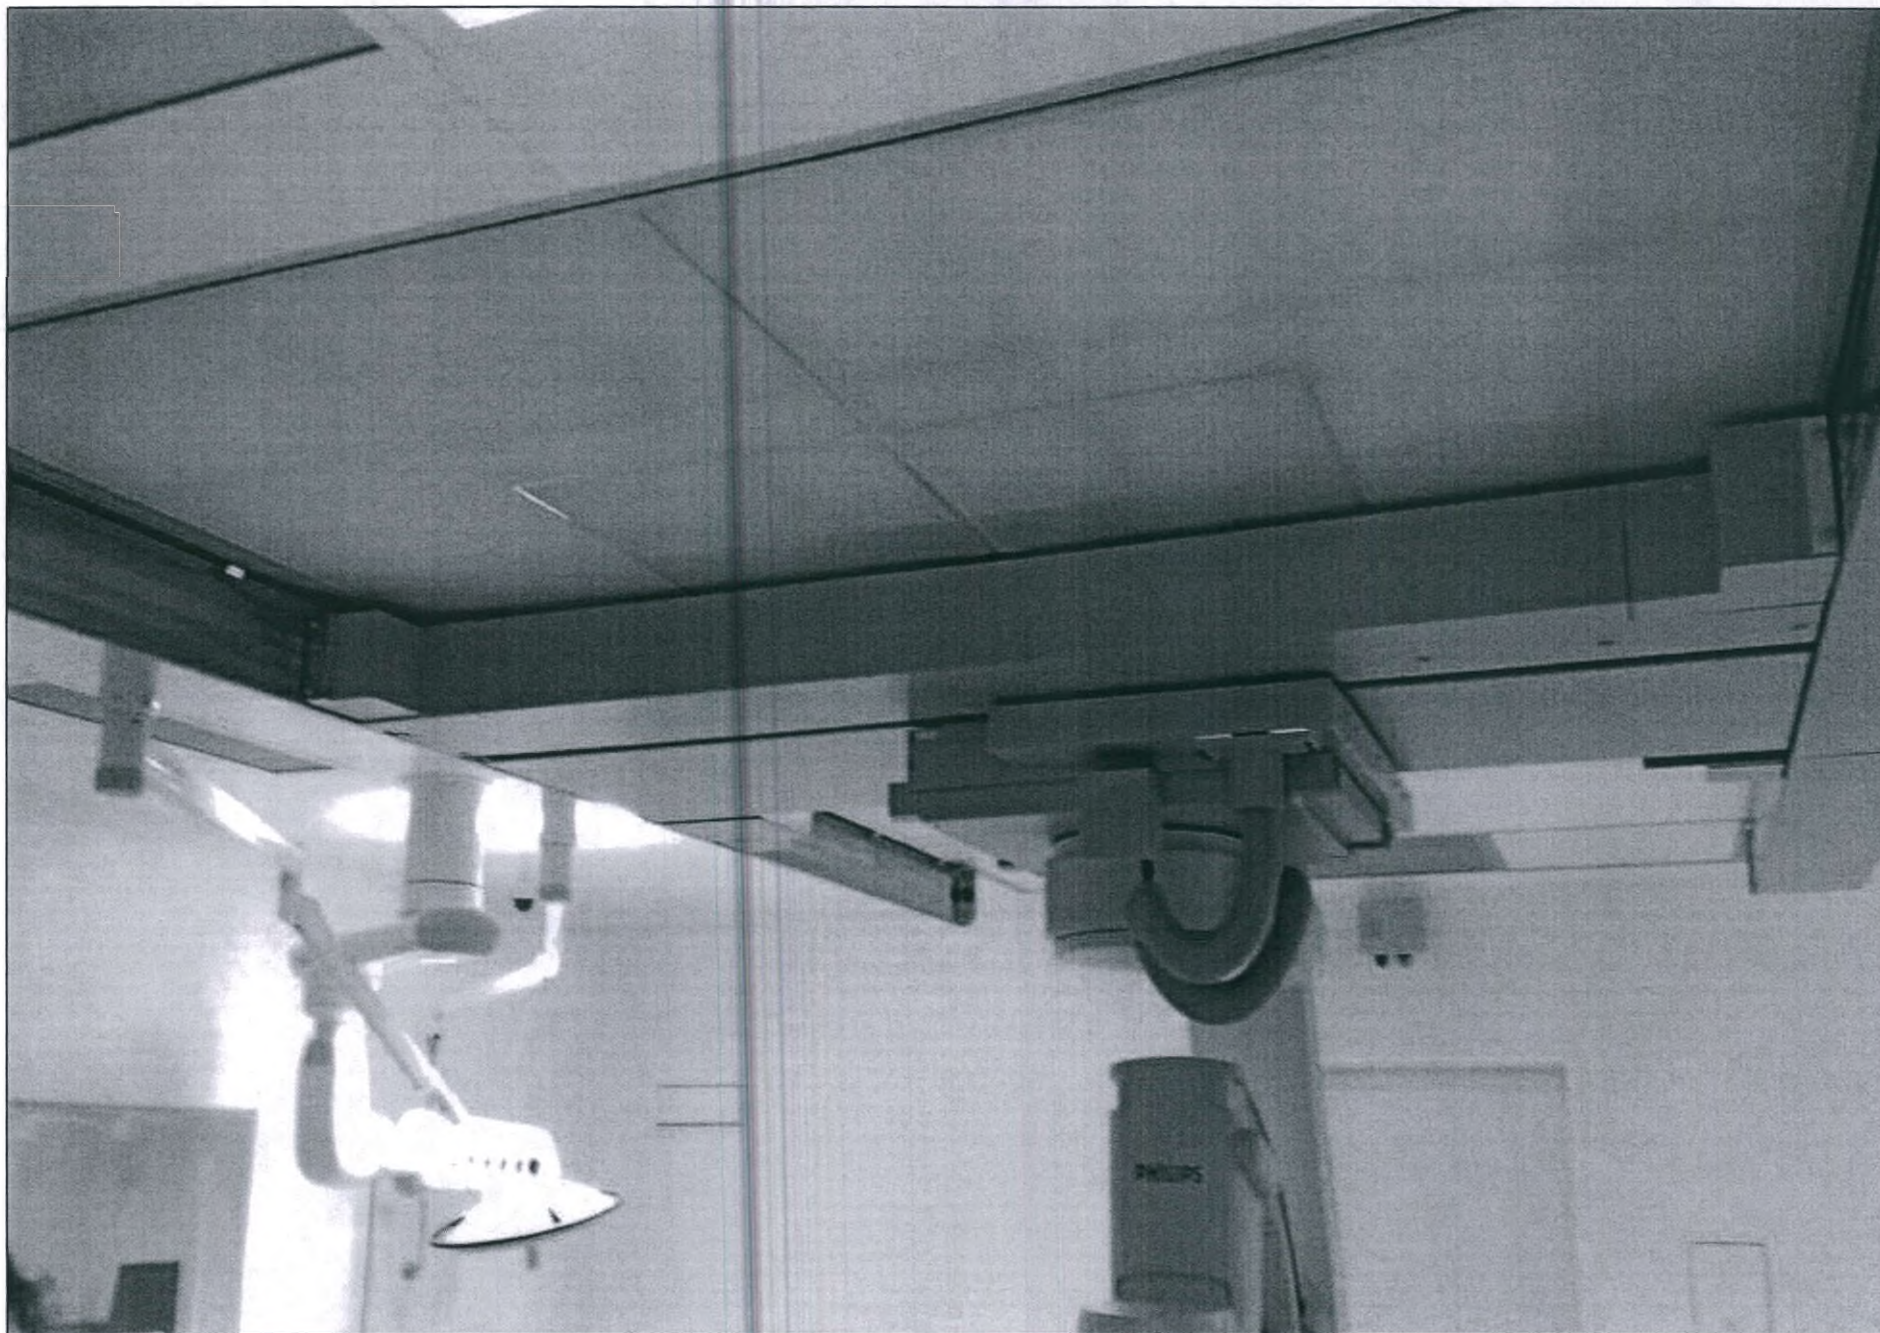


18. Подвес потолочный FlexMove для расширенного перемещения штатива С-дуги.




19. Подставка для модулей управления системой.

File E346485


PHO-02

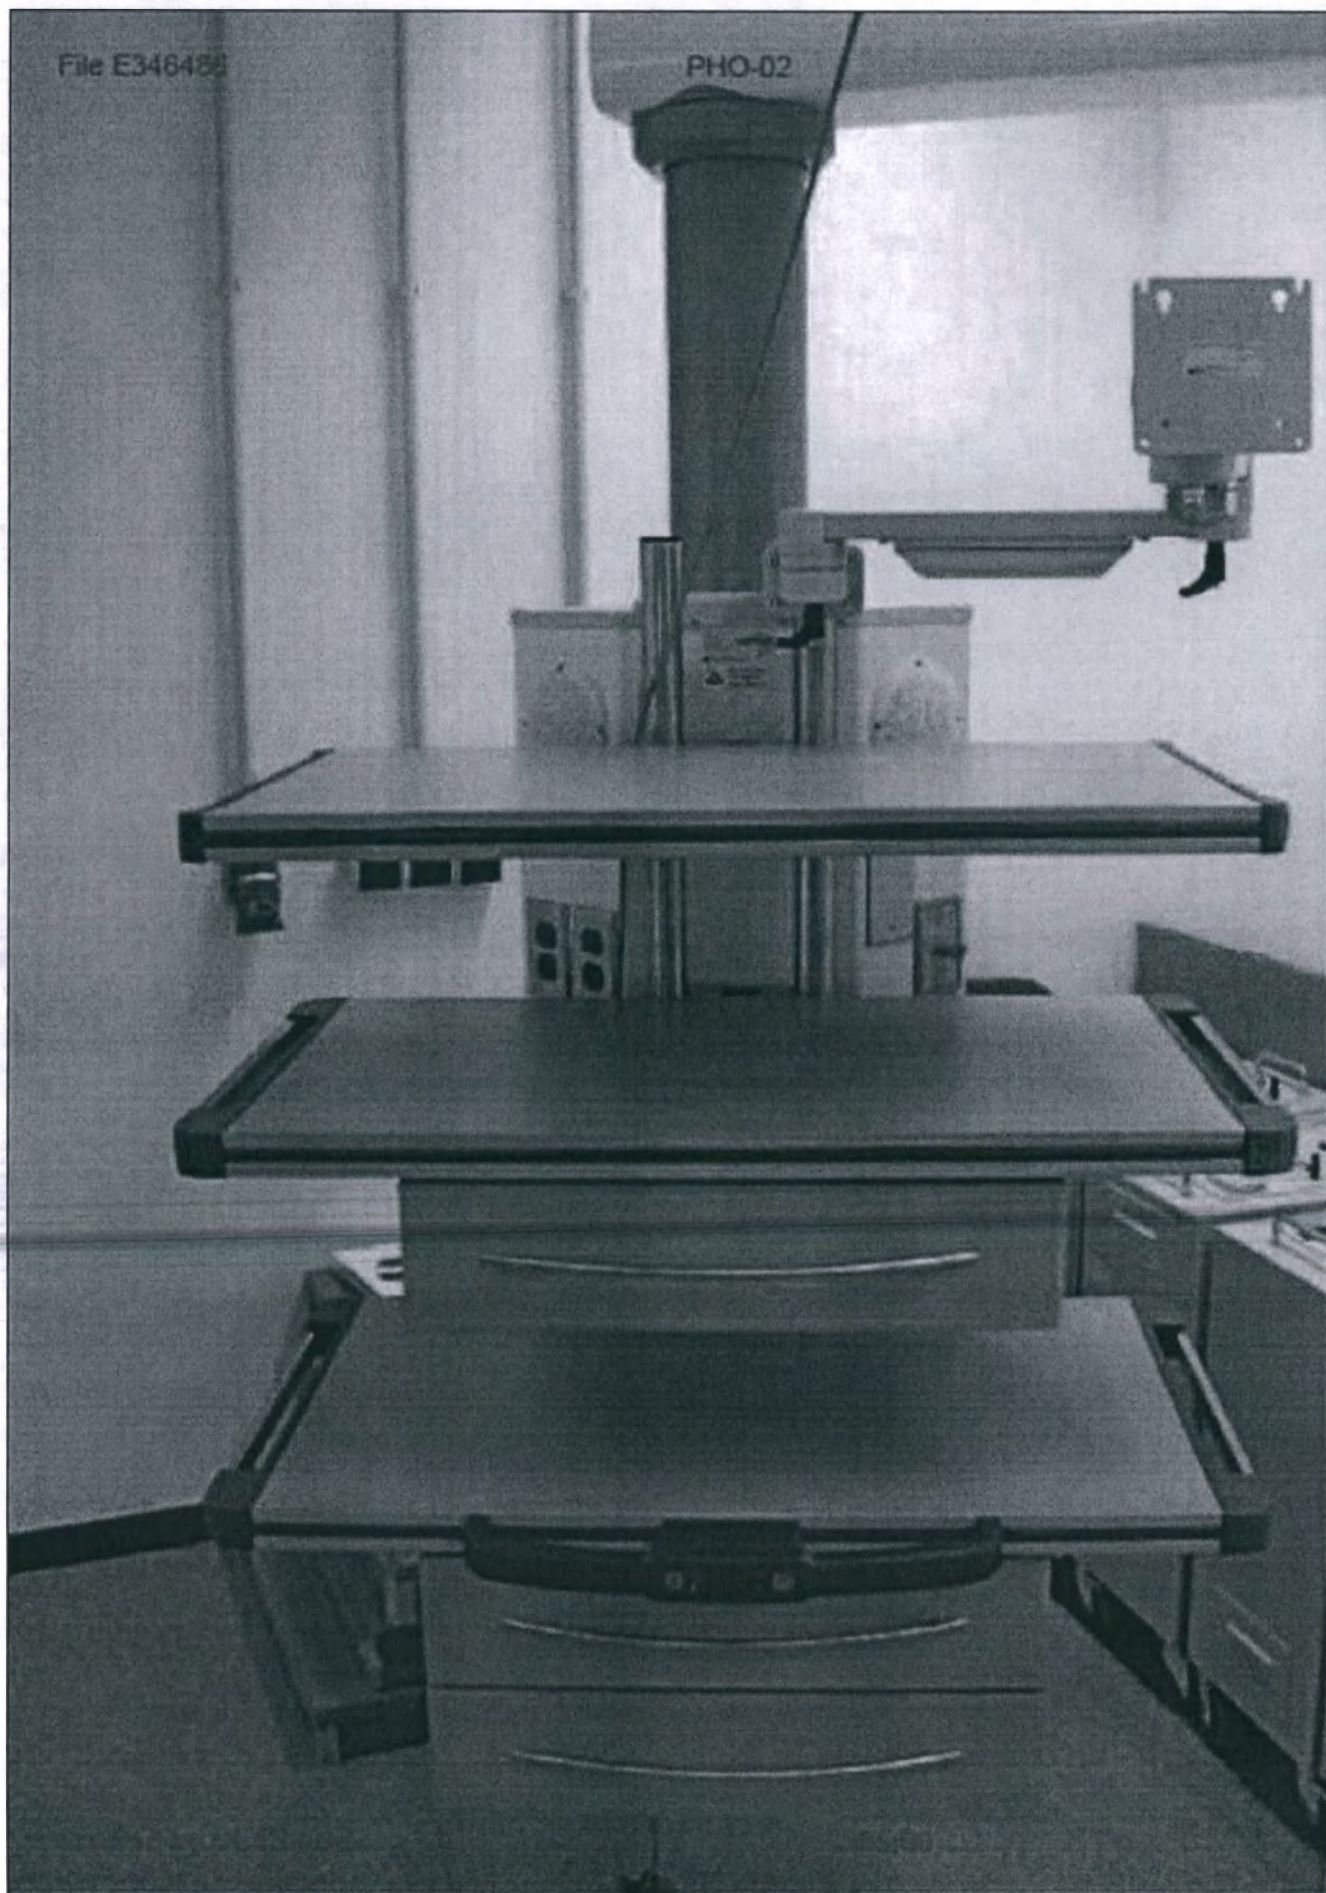


20. Стойка для оборудования.

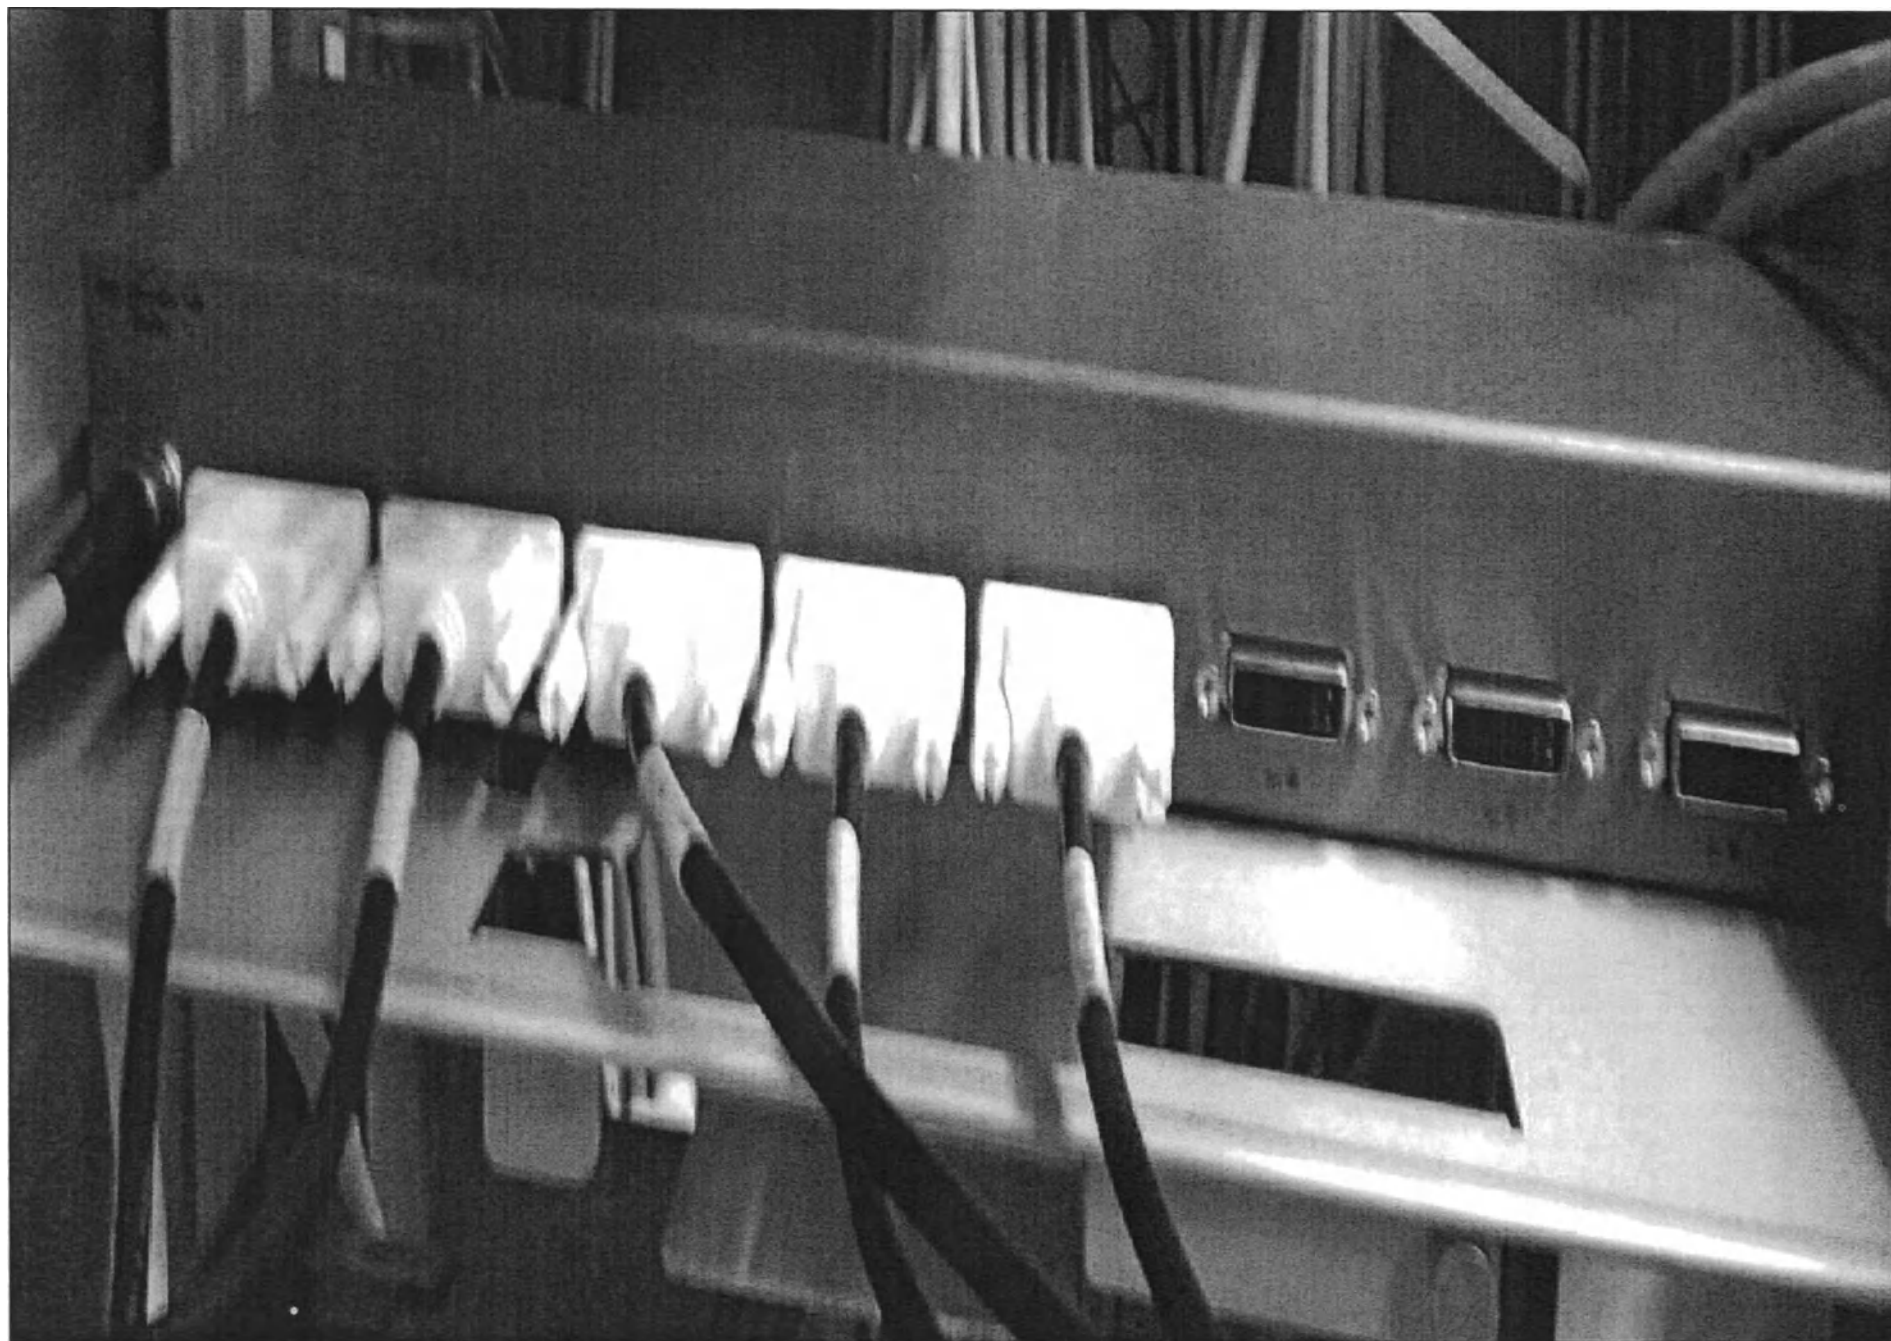


21. Устройство подключения дополнительного оборудования

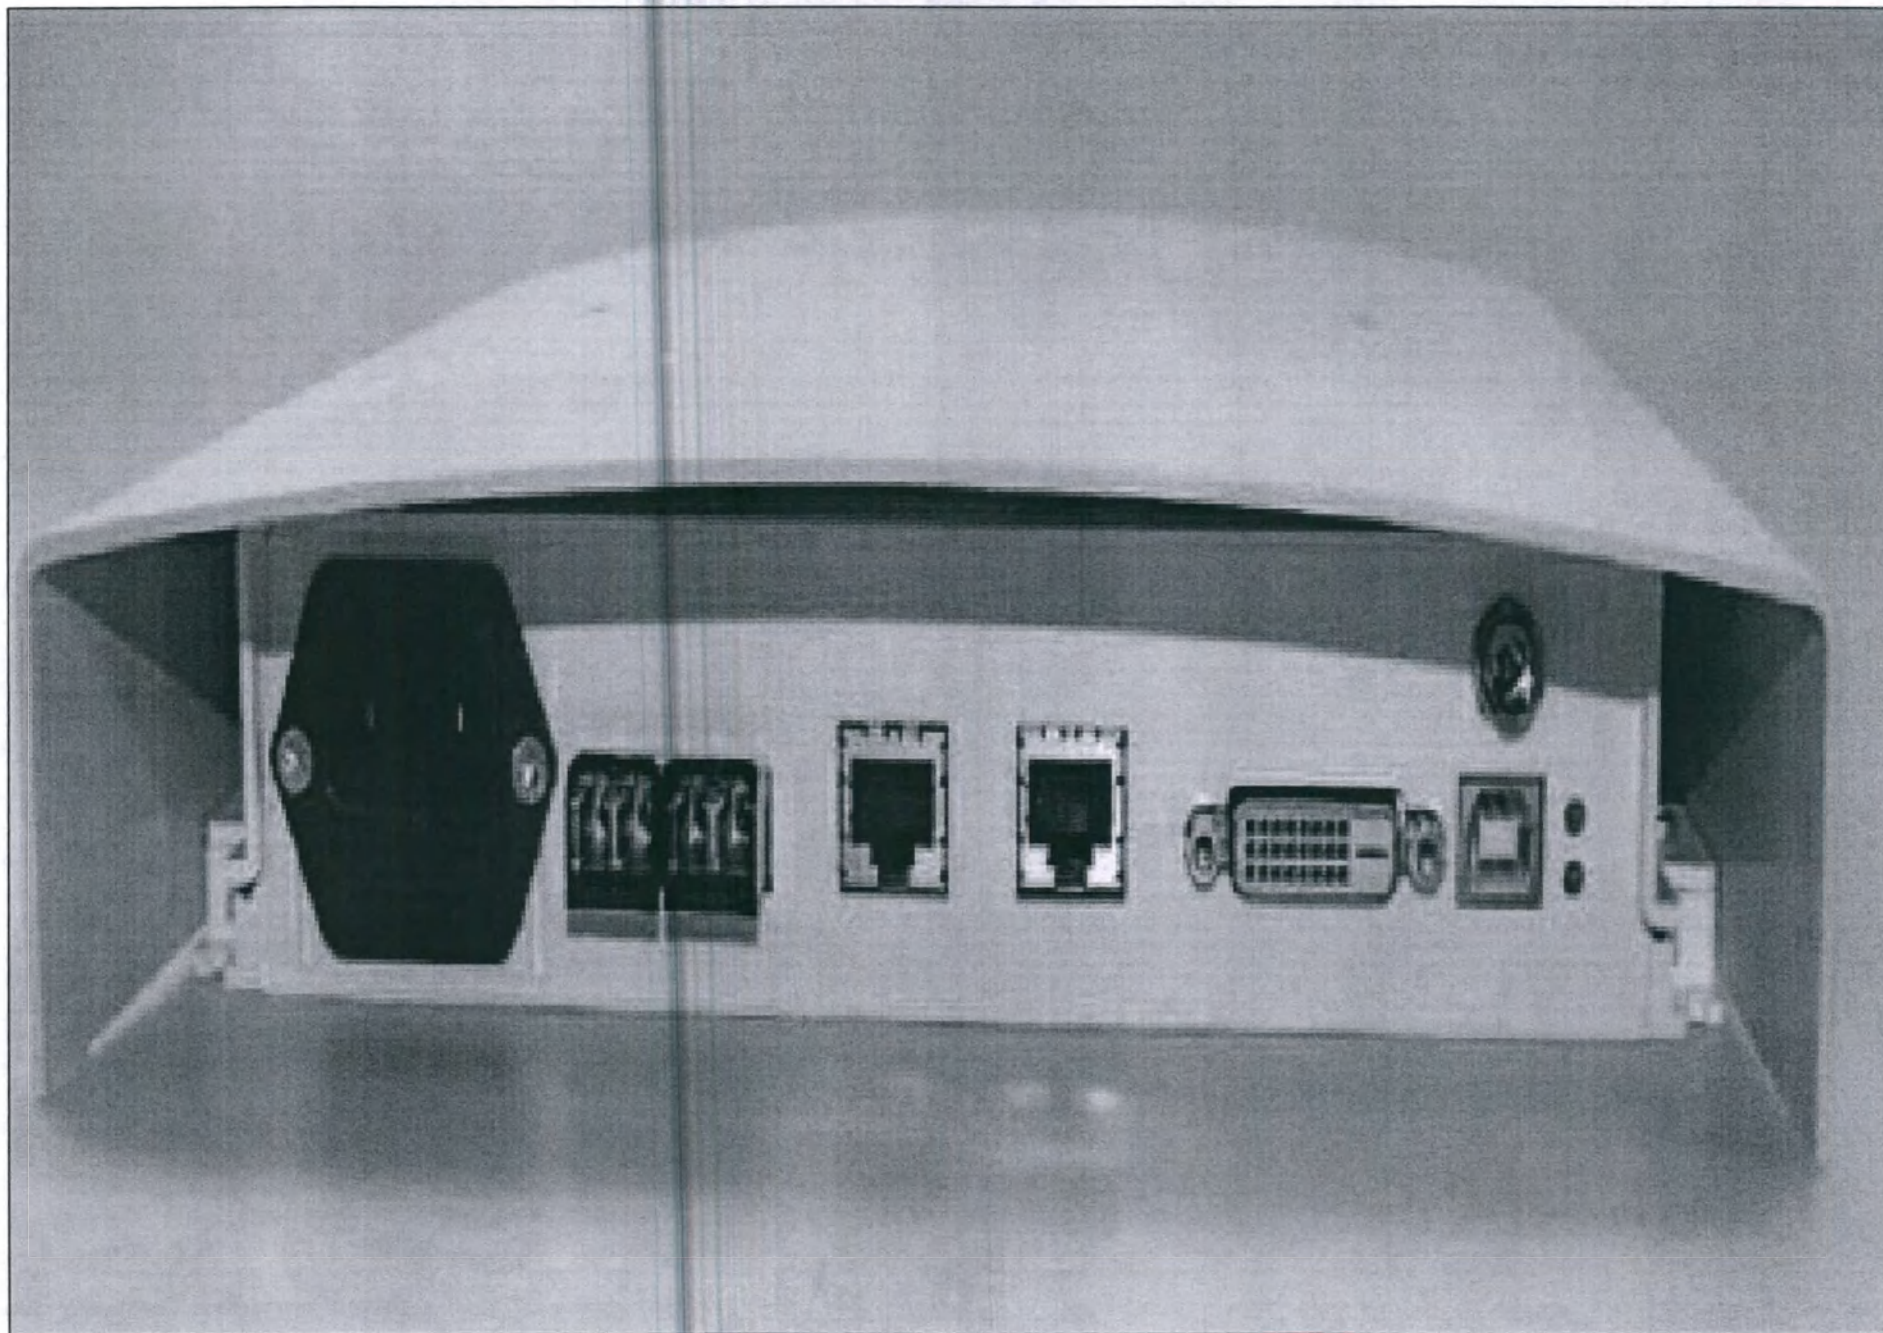


22.а. Настенная распределительная коробка

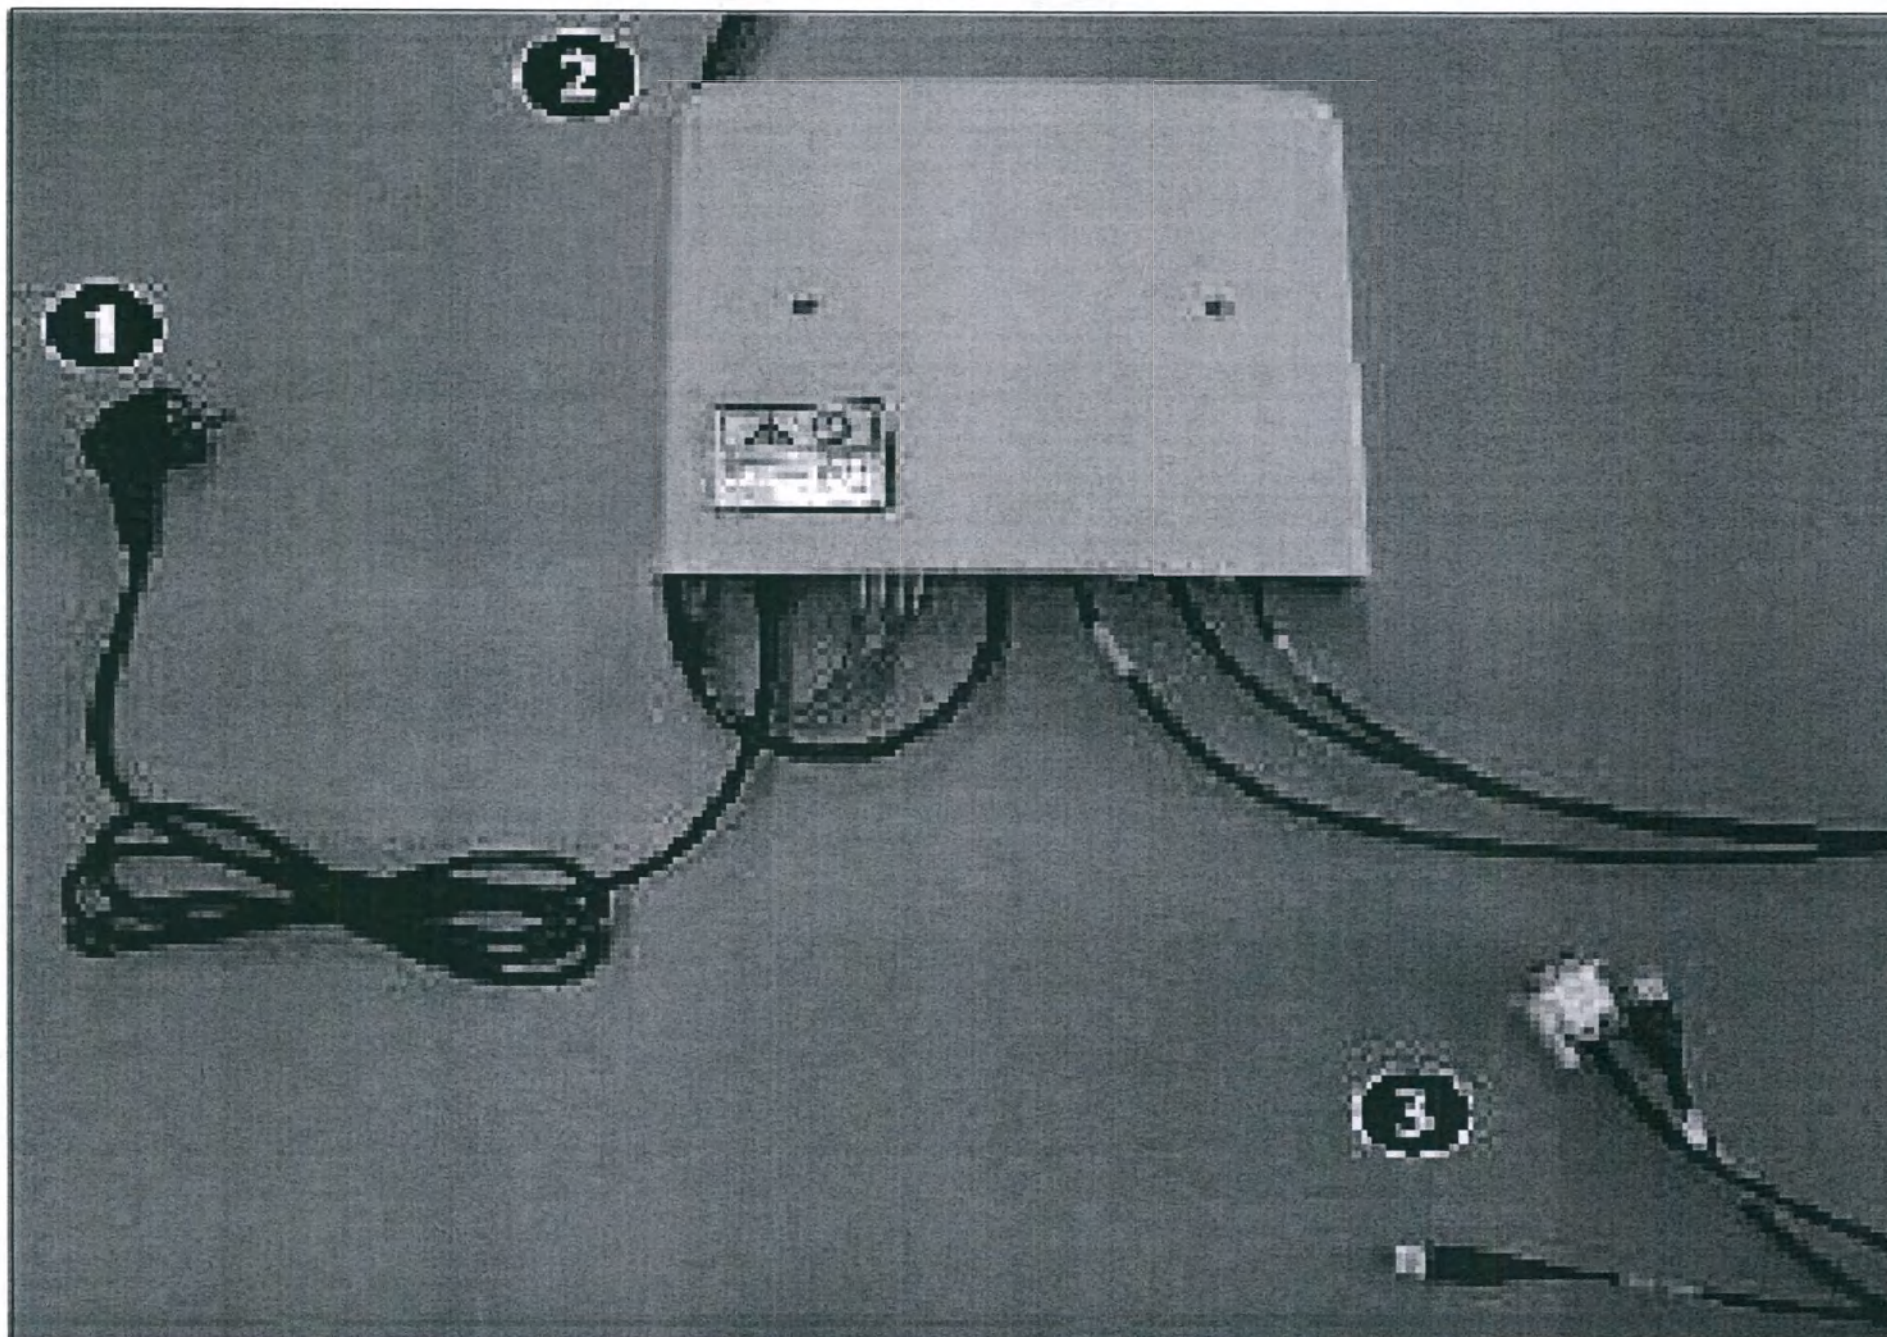


22.б. Настенная распределительная коробка

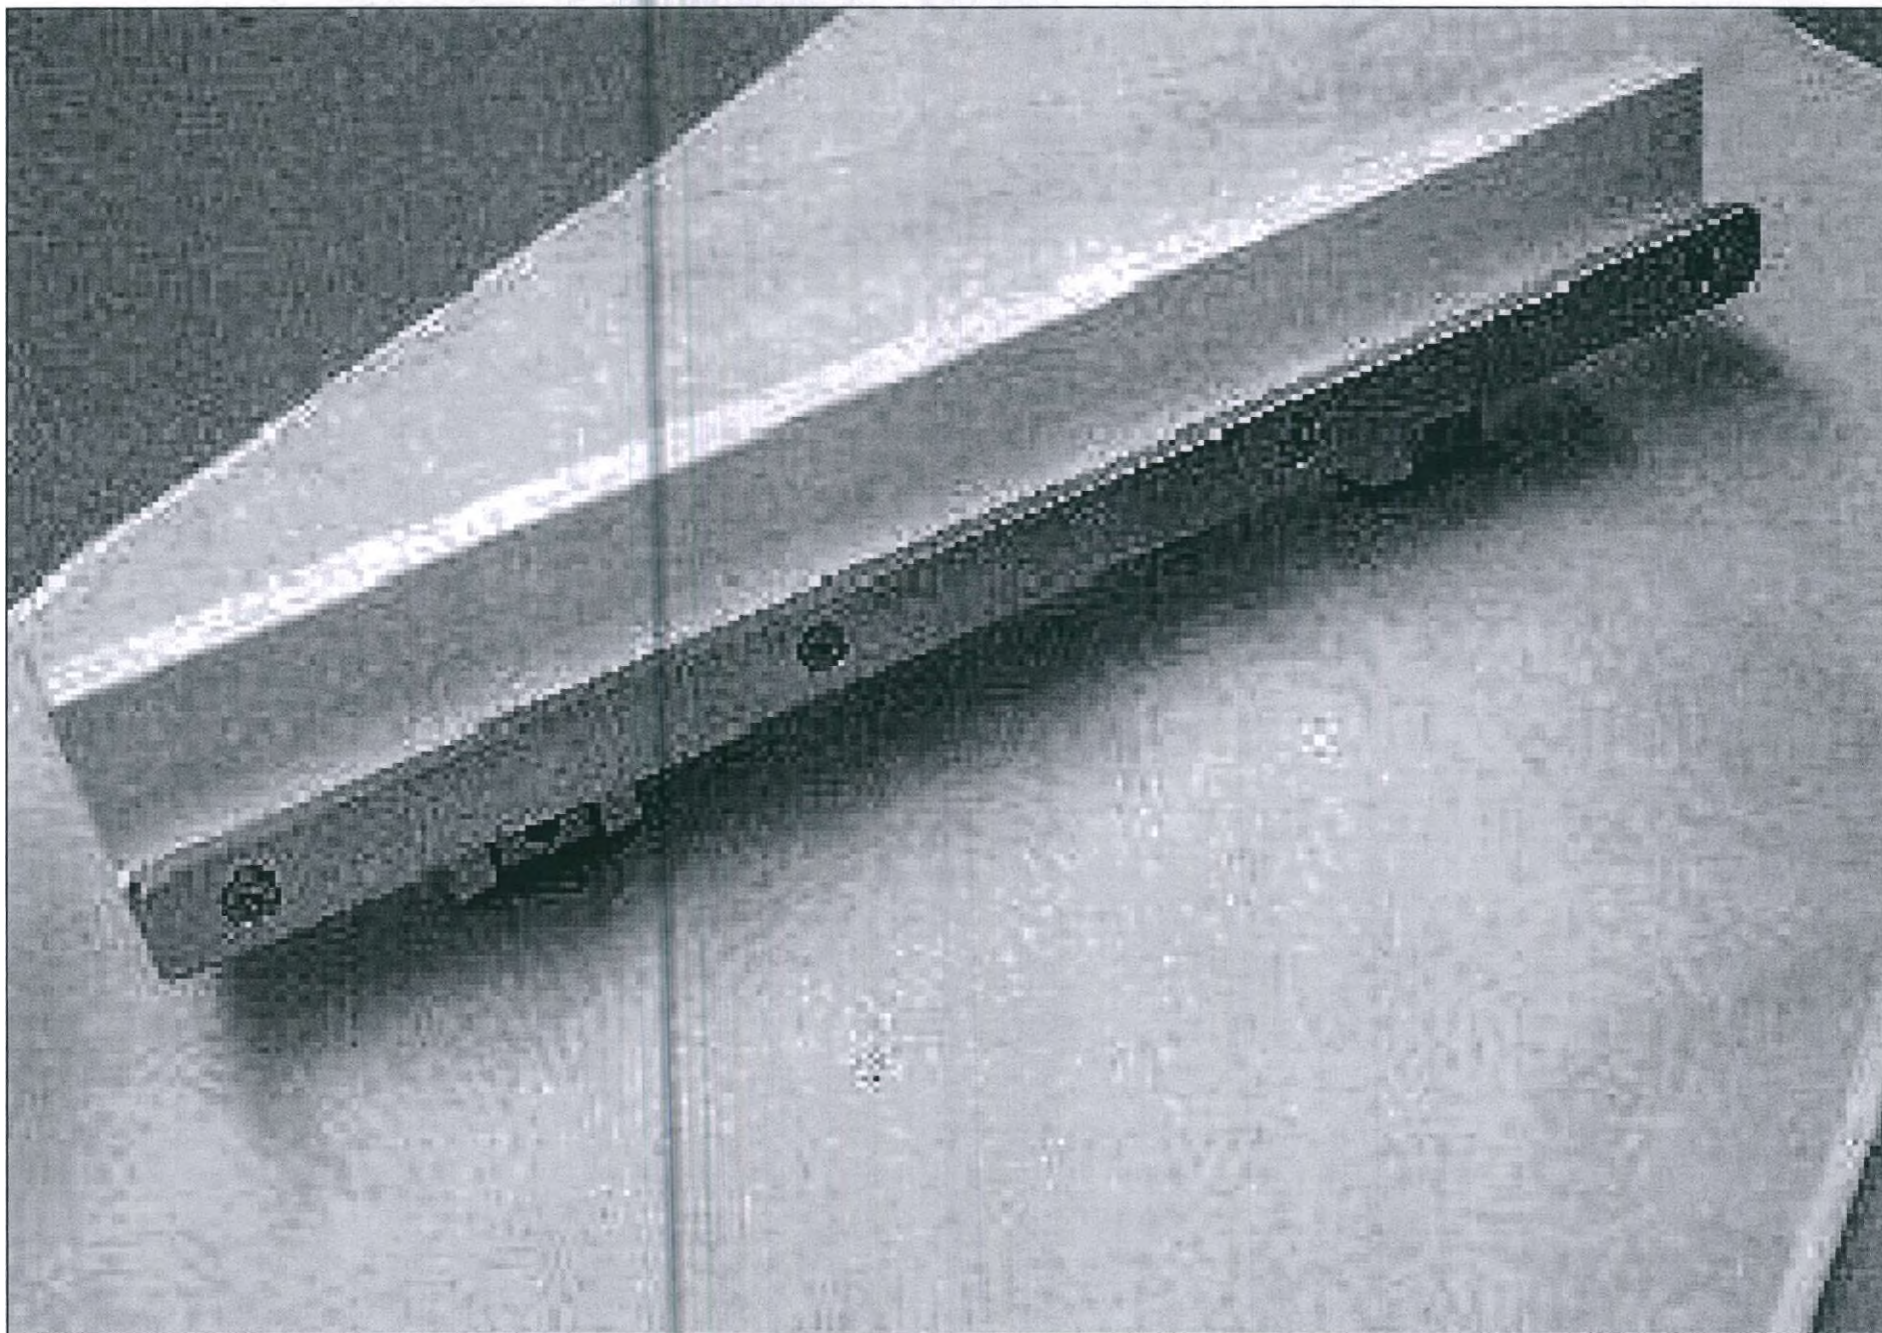


23.а. Рельс для крепления принадлежностей на столе пациента.

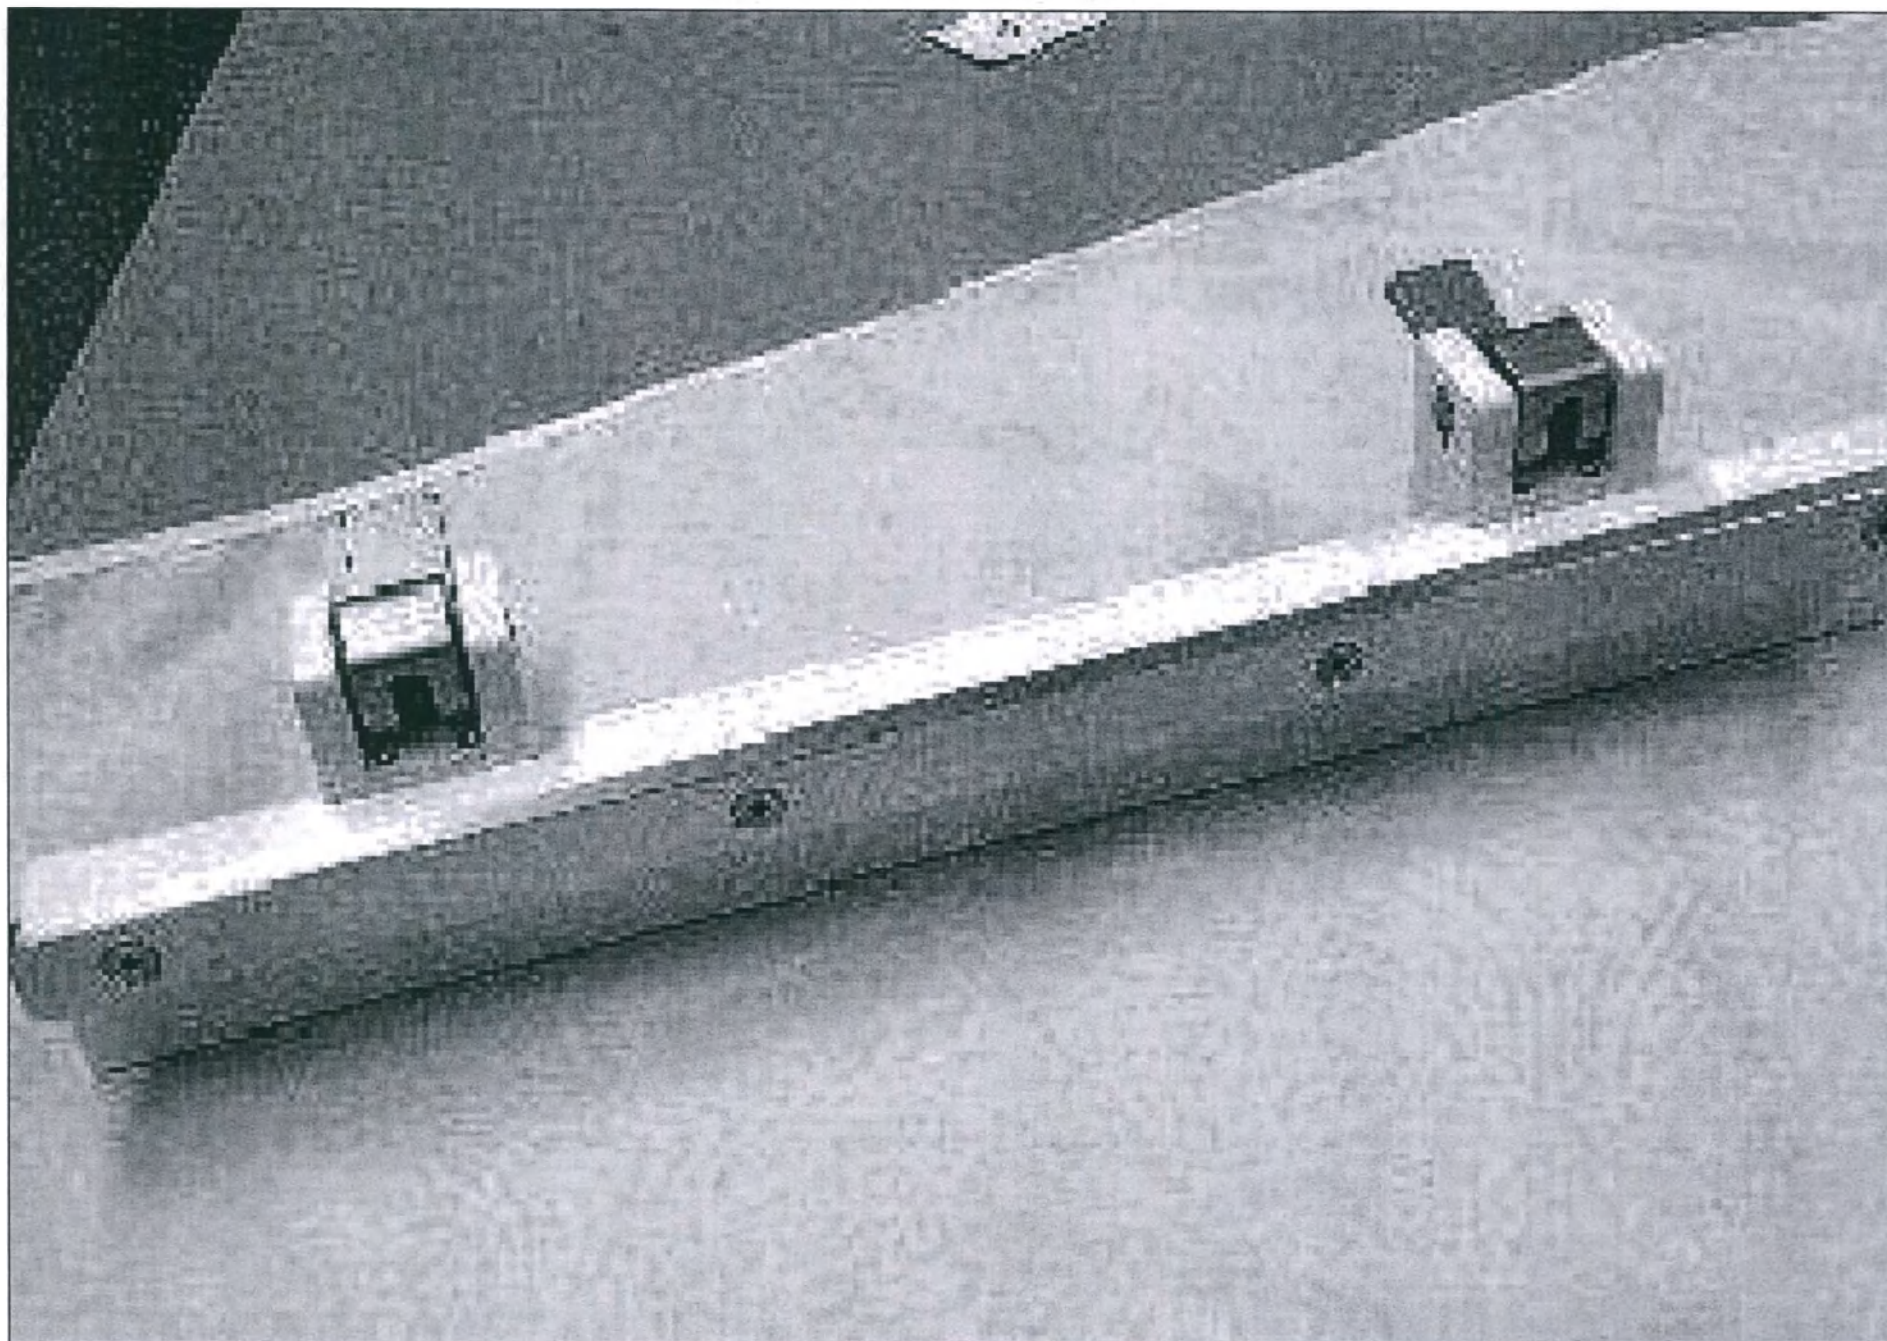


23.б. Рельс для крепления принадлежностей на столе пациента.

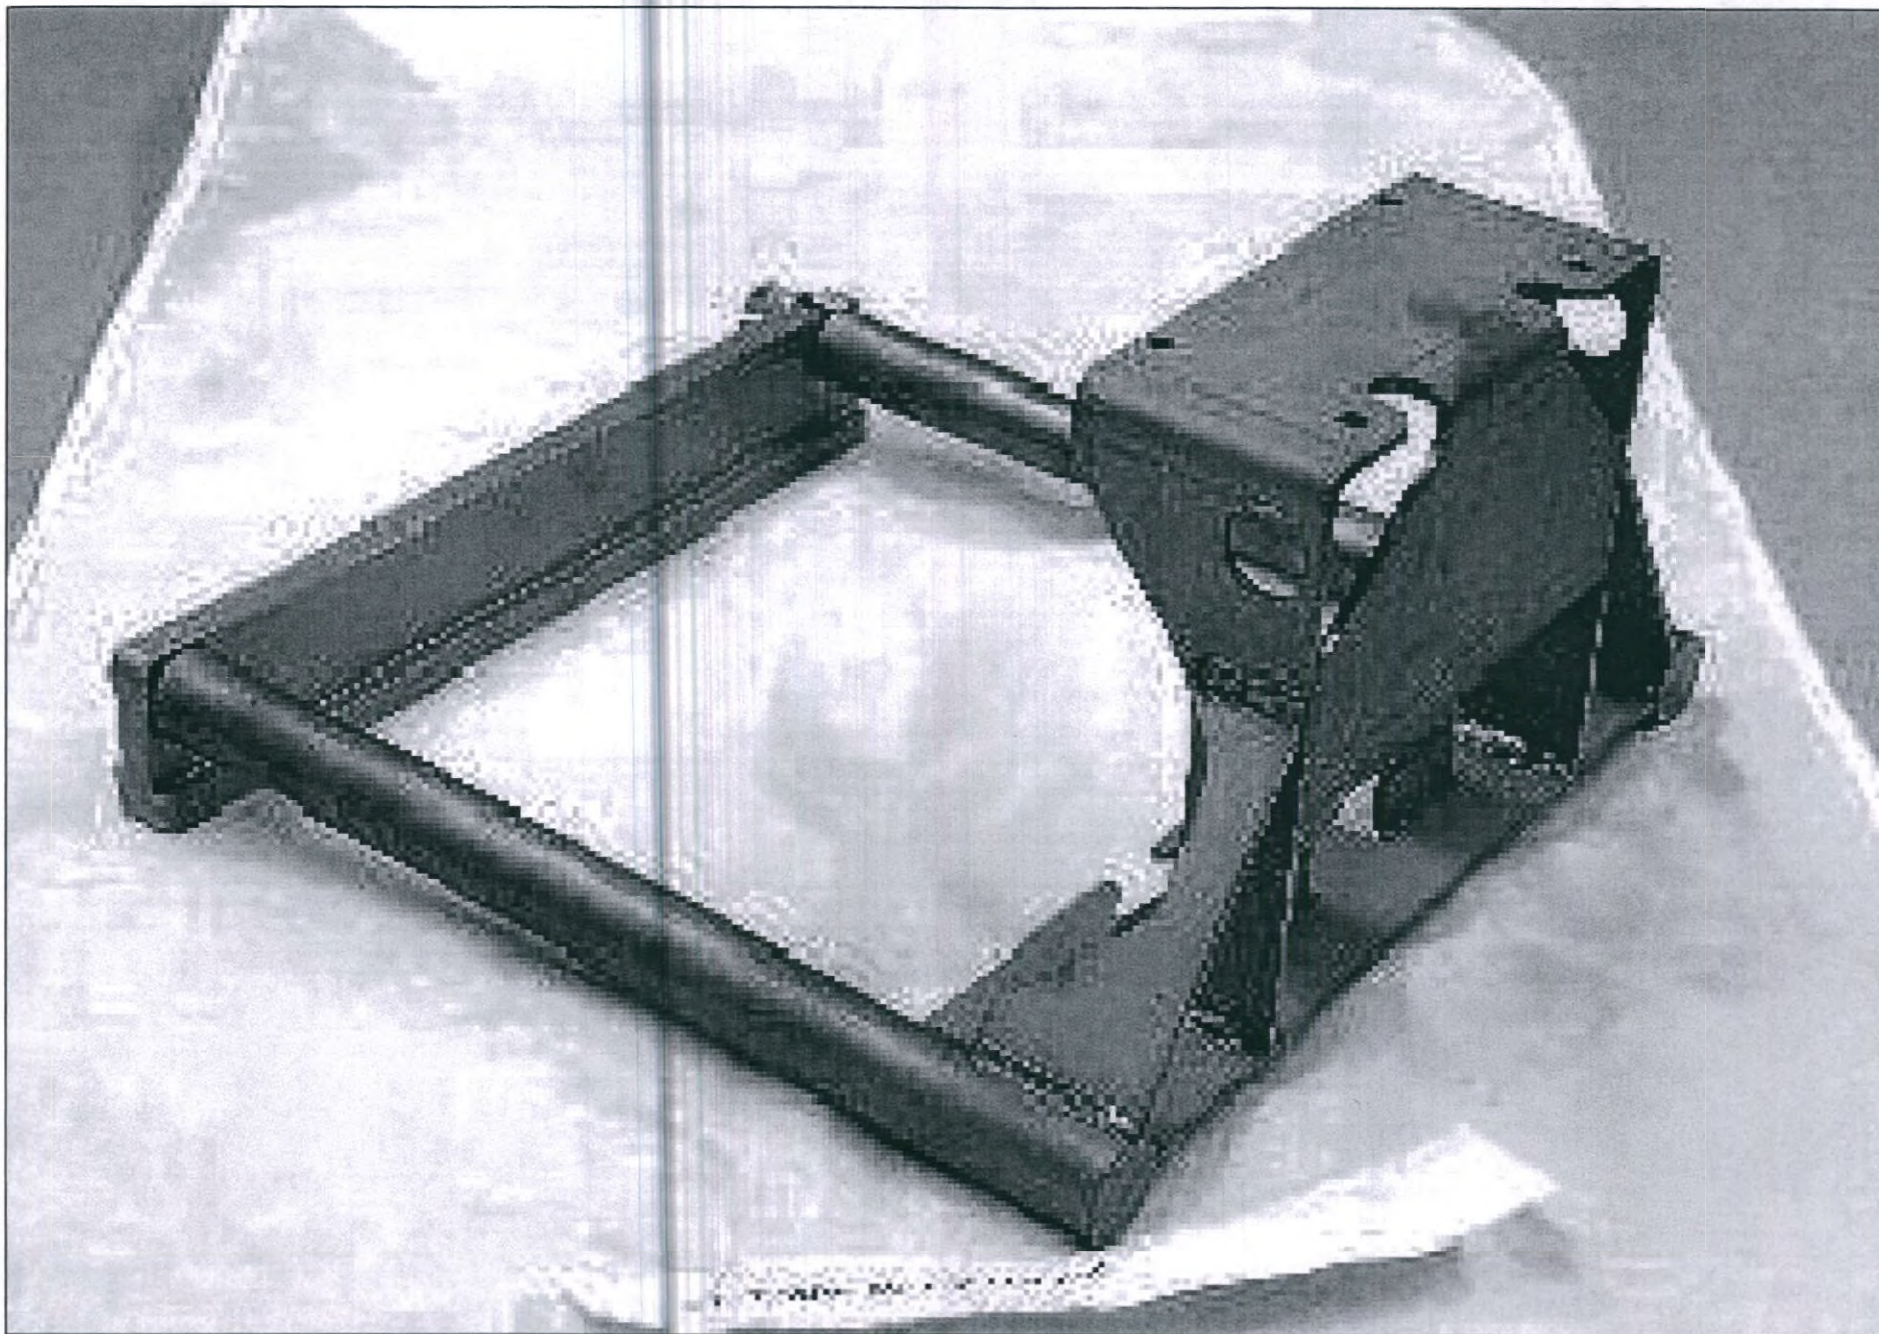


24.а. Вспомогательный рельс для крепления принадлежностей на столе пациента.

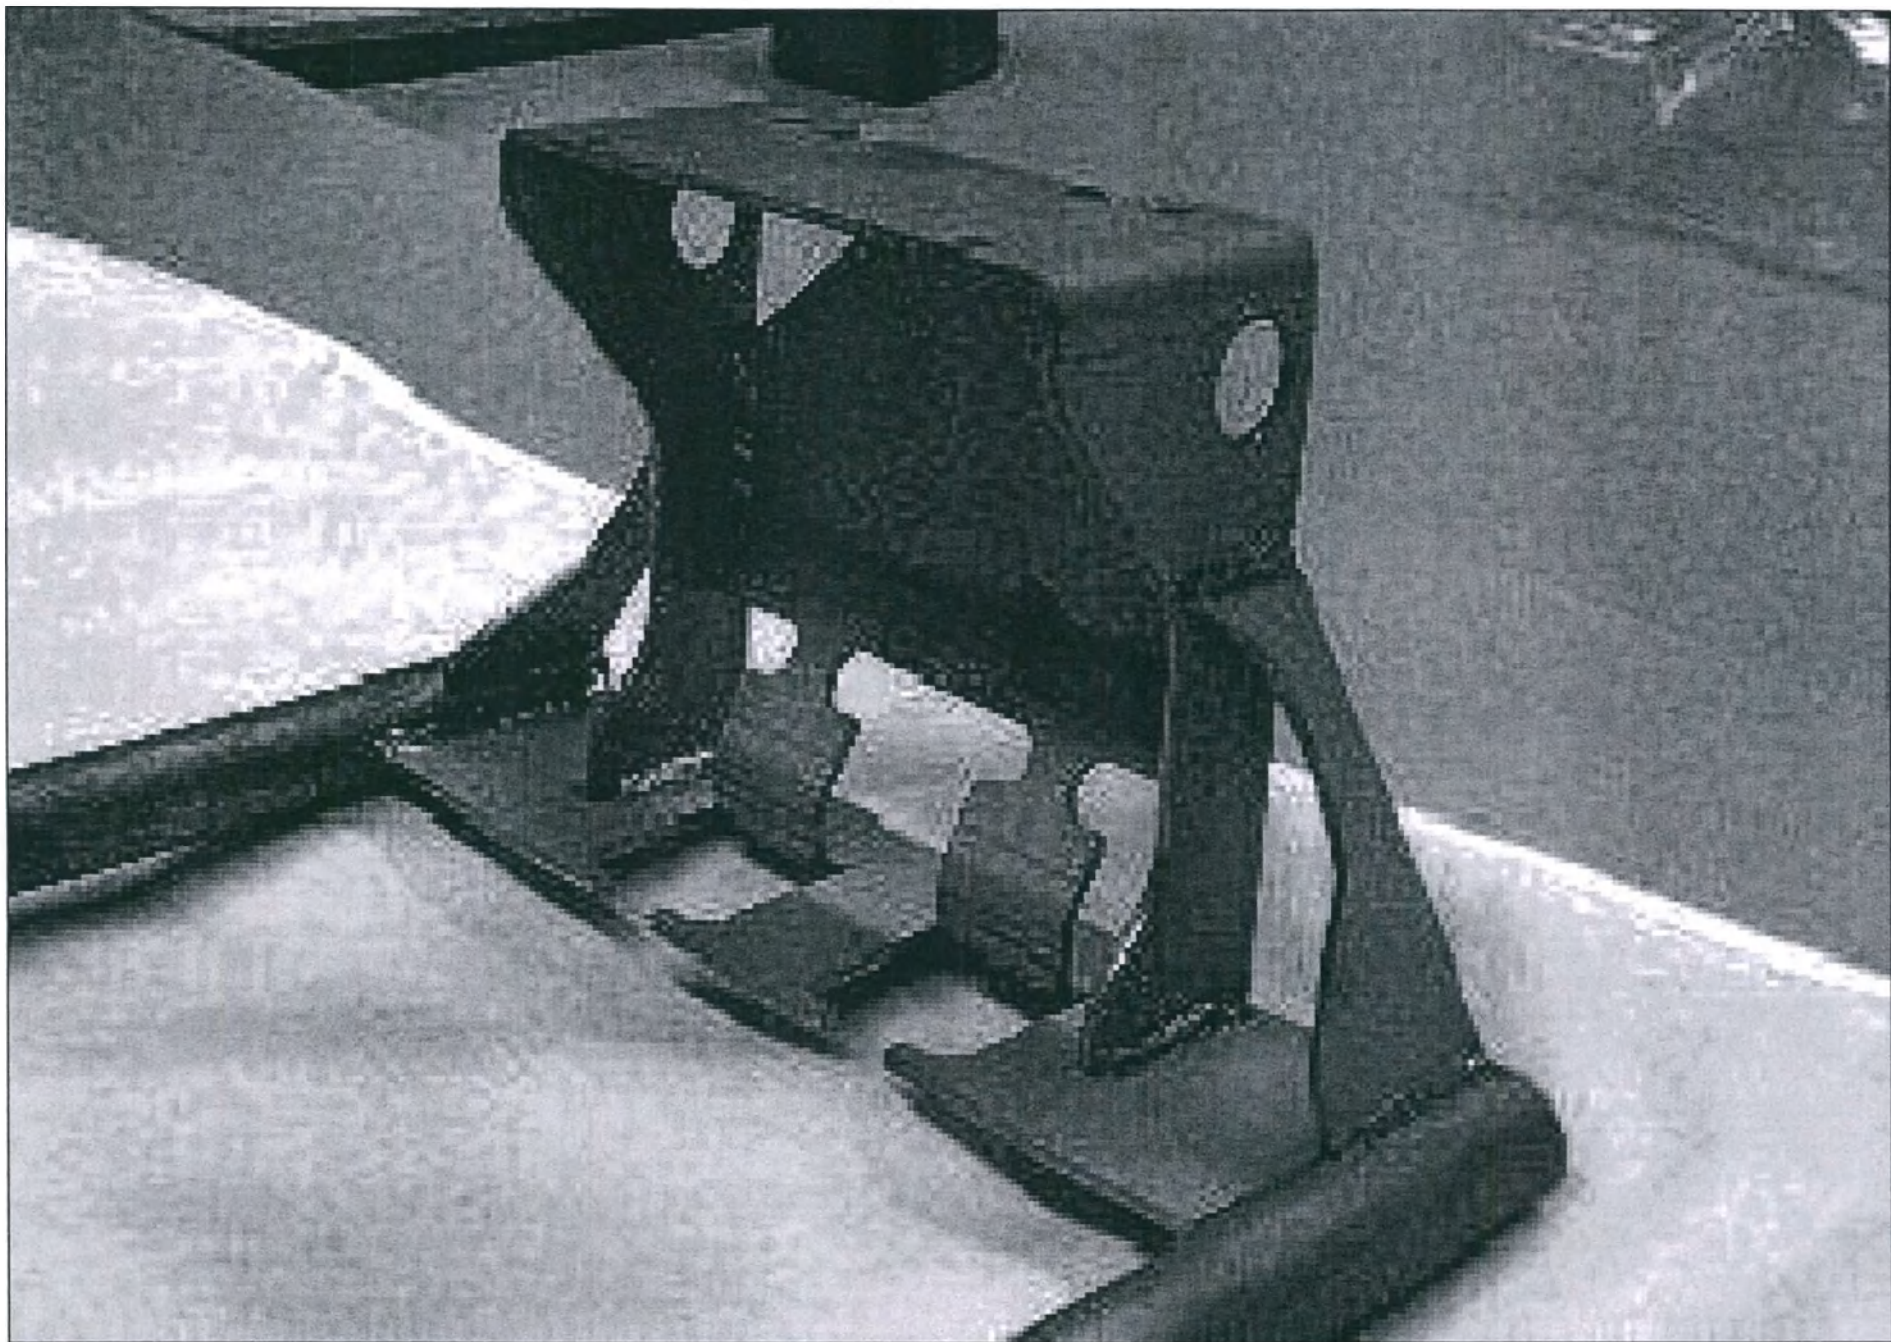


24.б. Вспомогательный рельс для крепления принадлежностей на столе пациента.

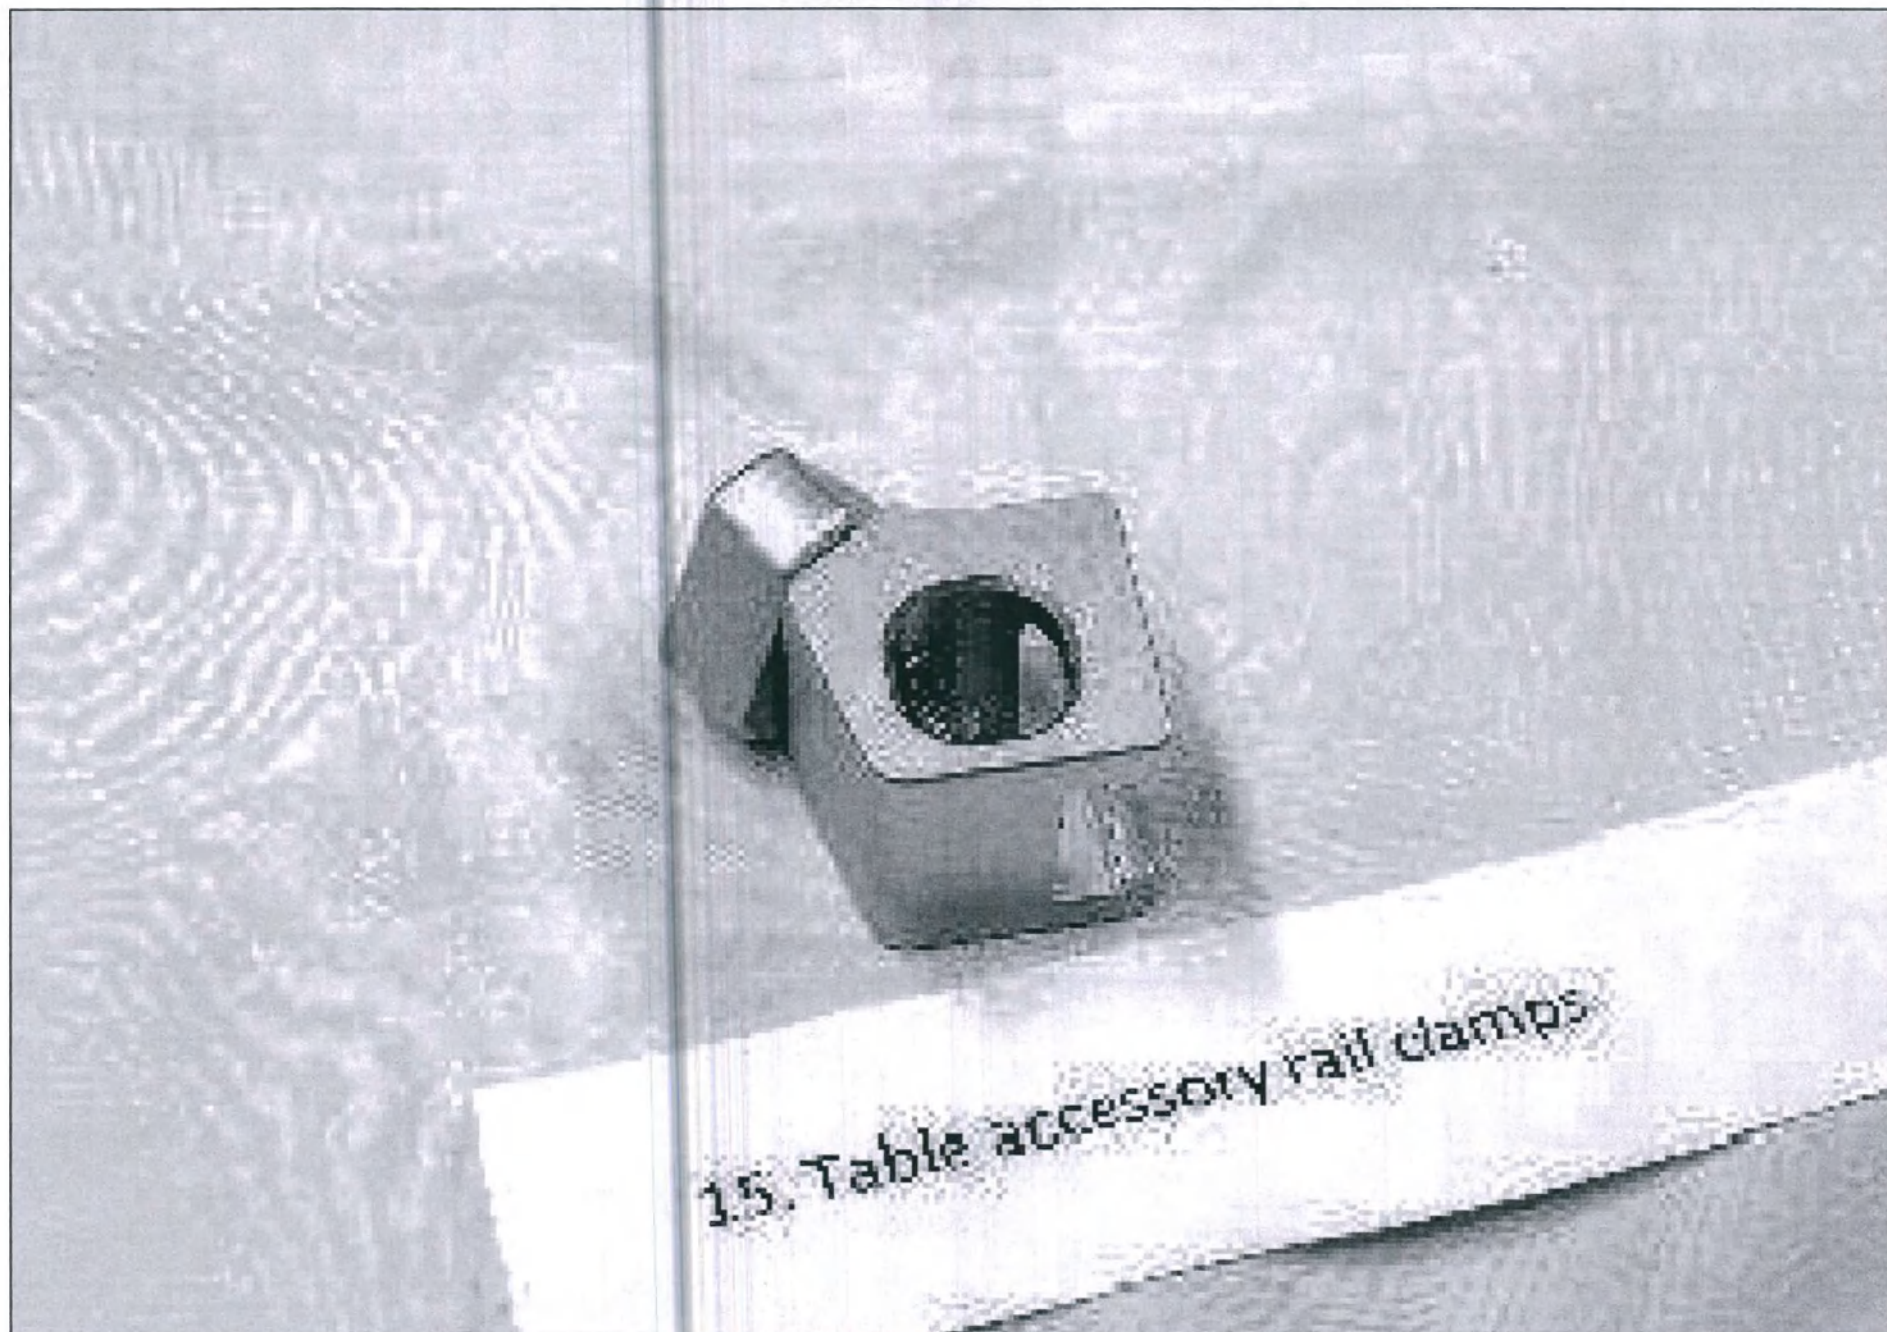


25.а. Зажимы для крепления принадлежностей на рельсе стола

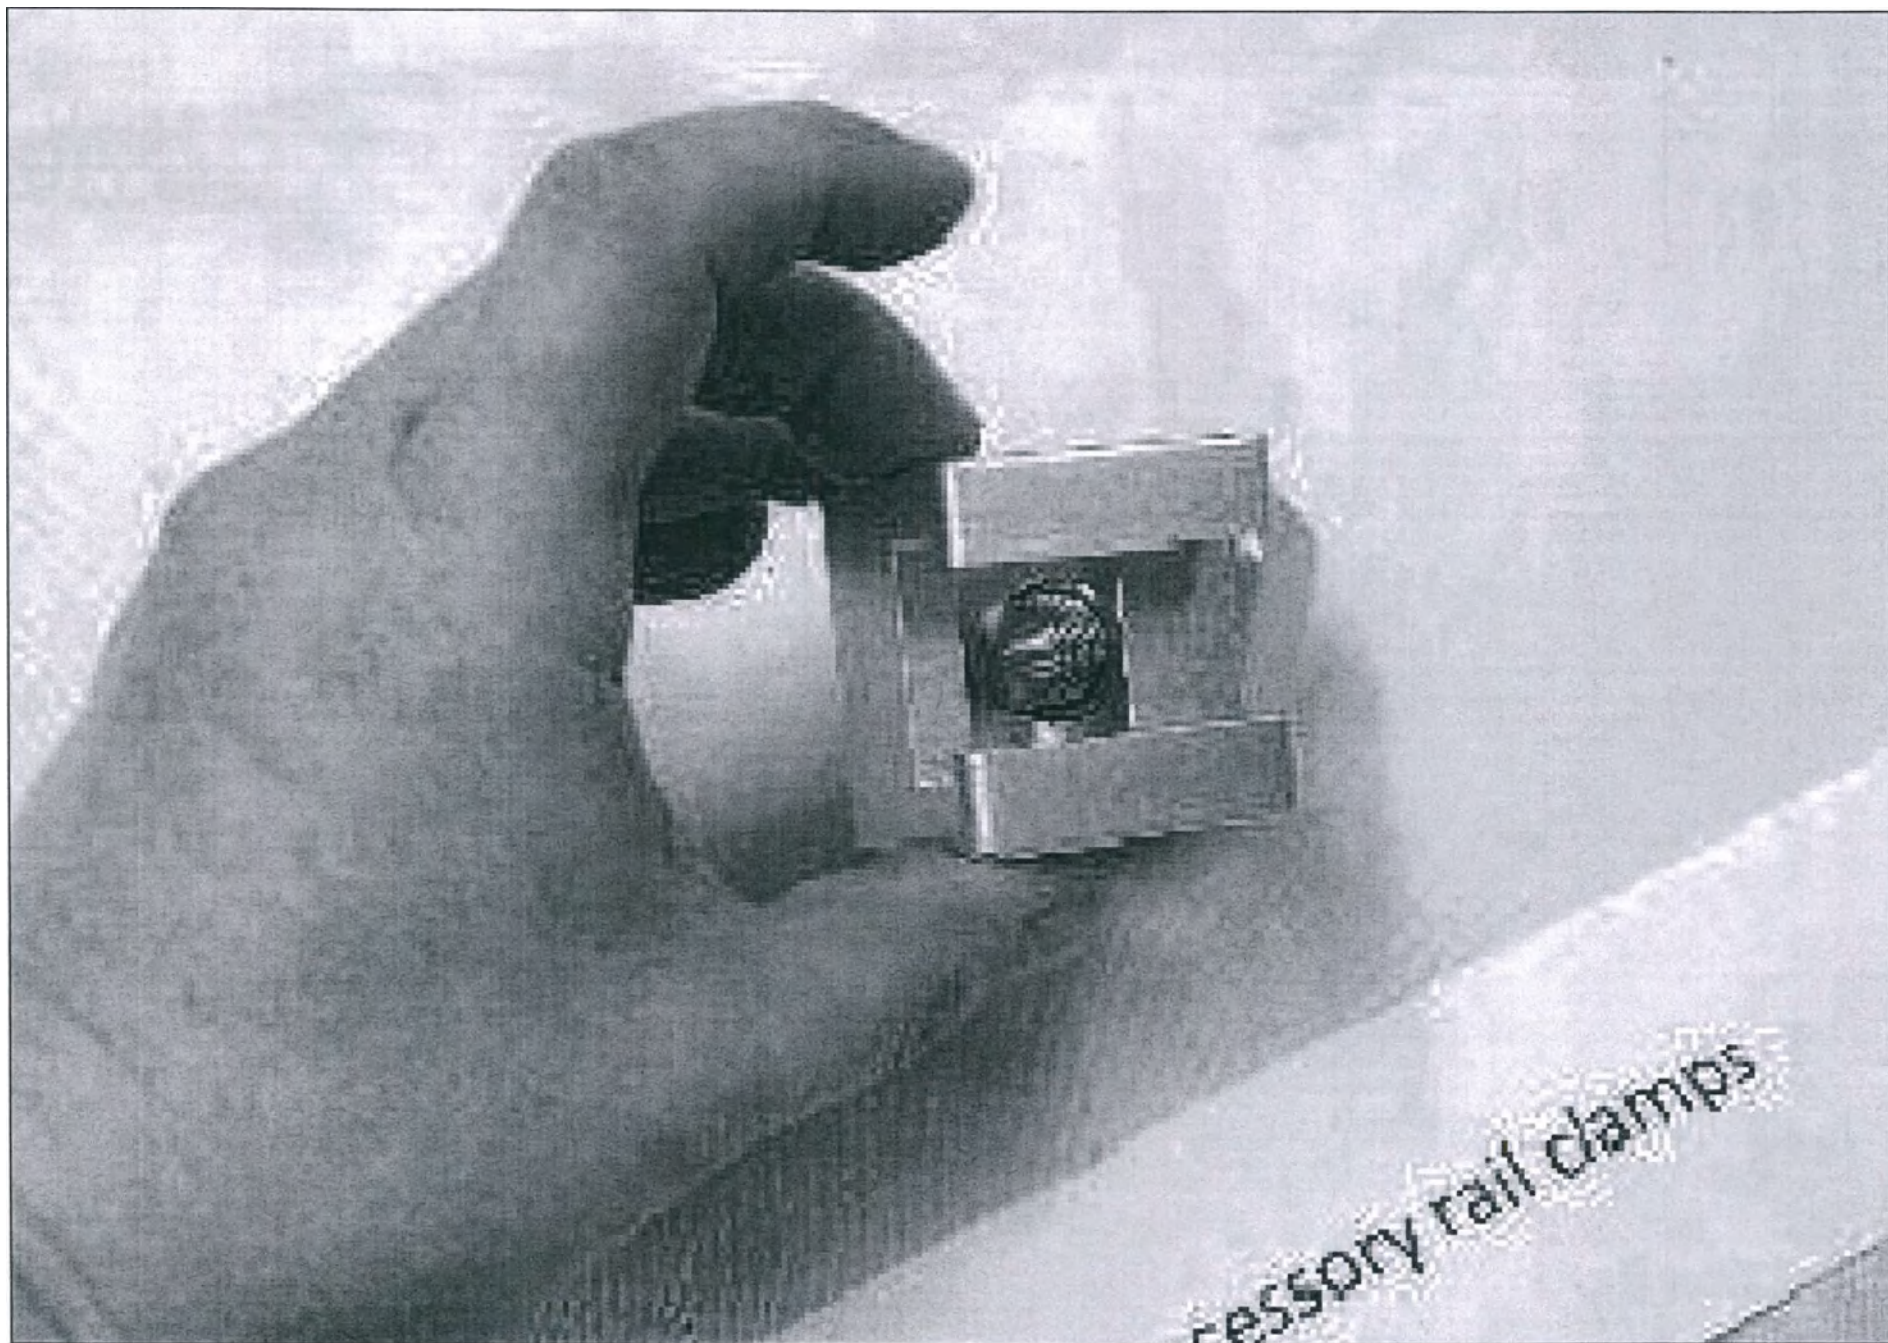


25.б. Зажимы для крепления принадлежностей на рельсе стола

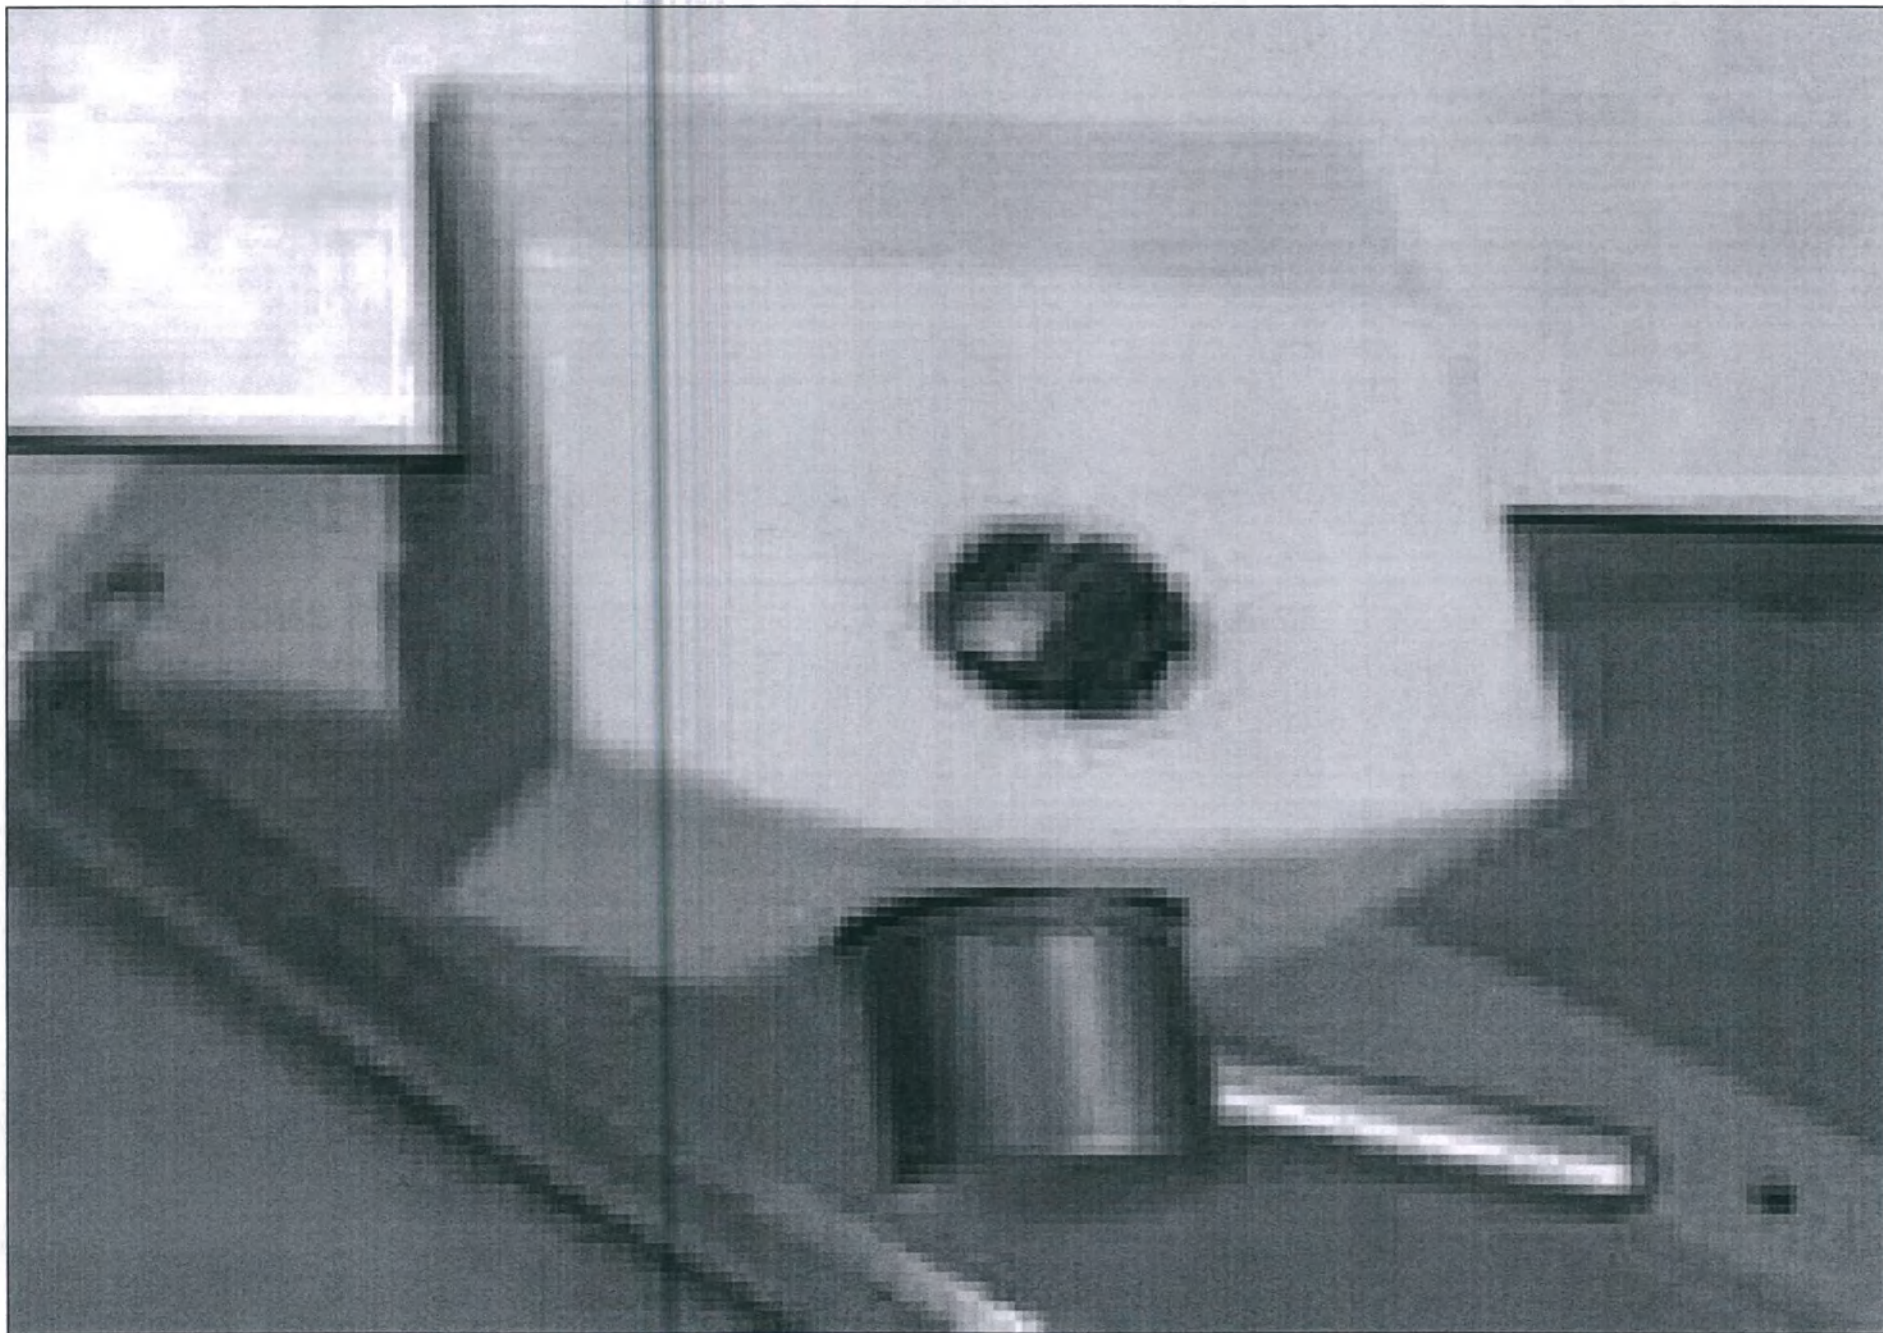


26. Зажимы для крепления принадлежностей на деке стола

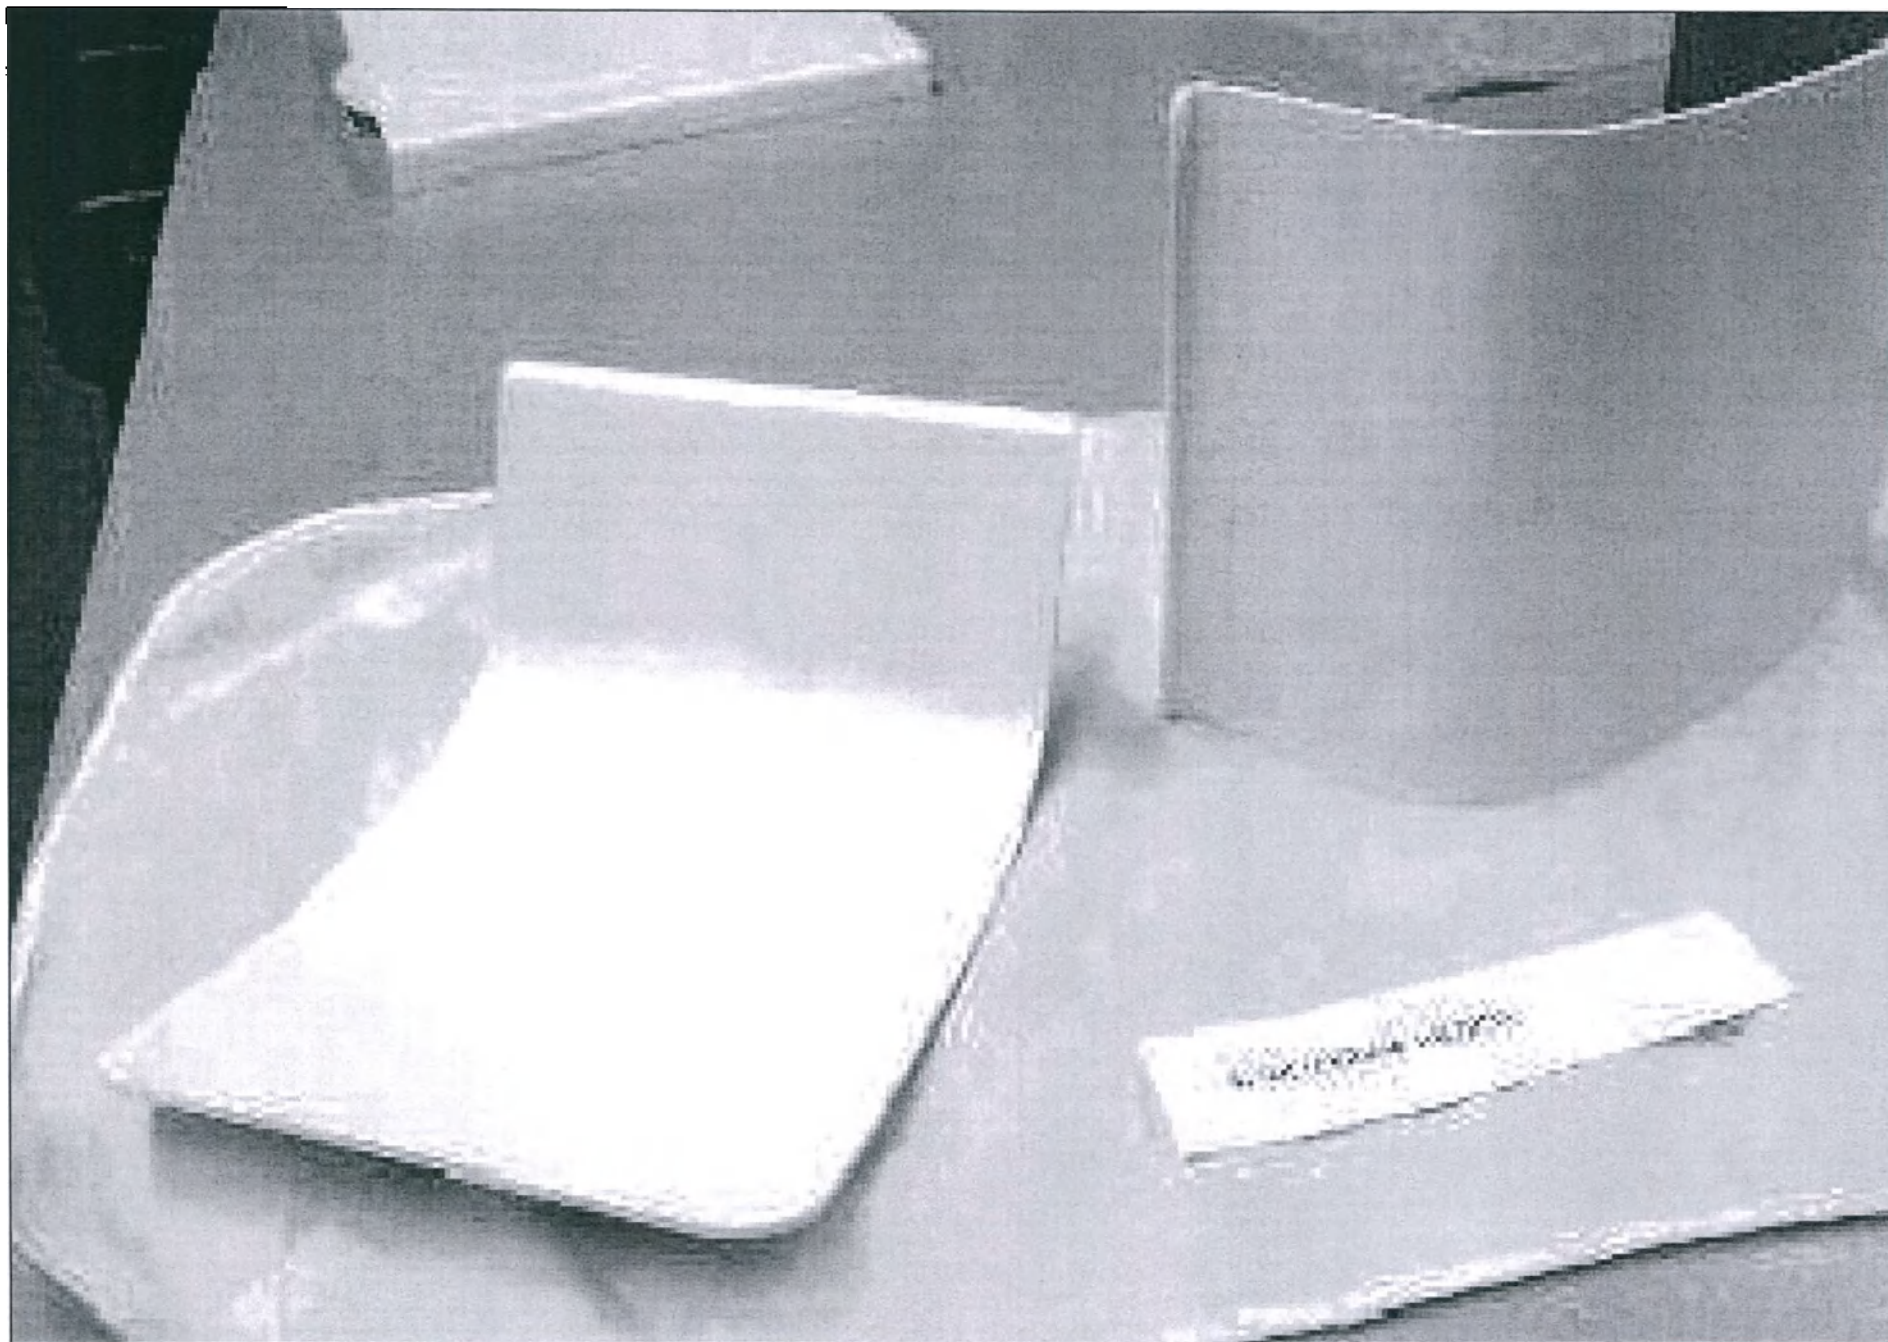


27. Комплект подлокотников

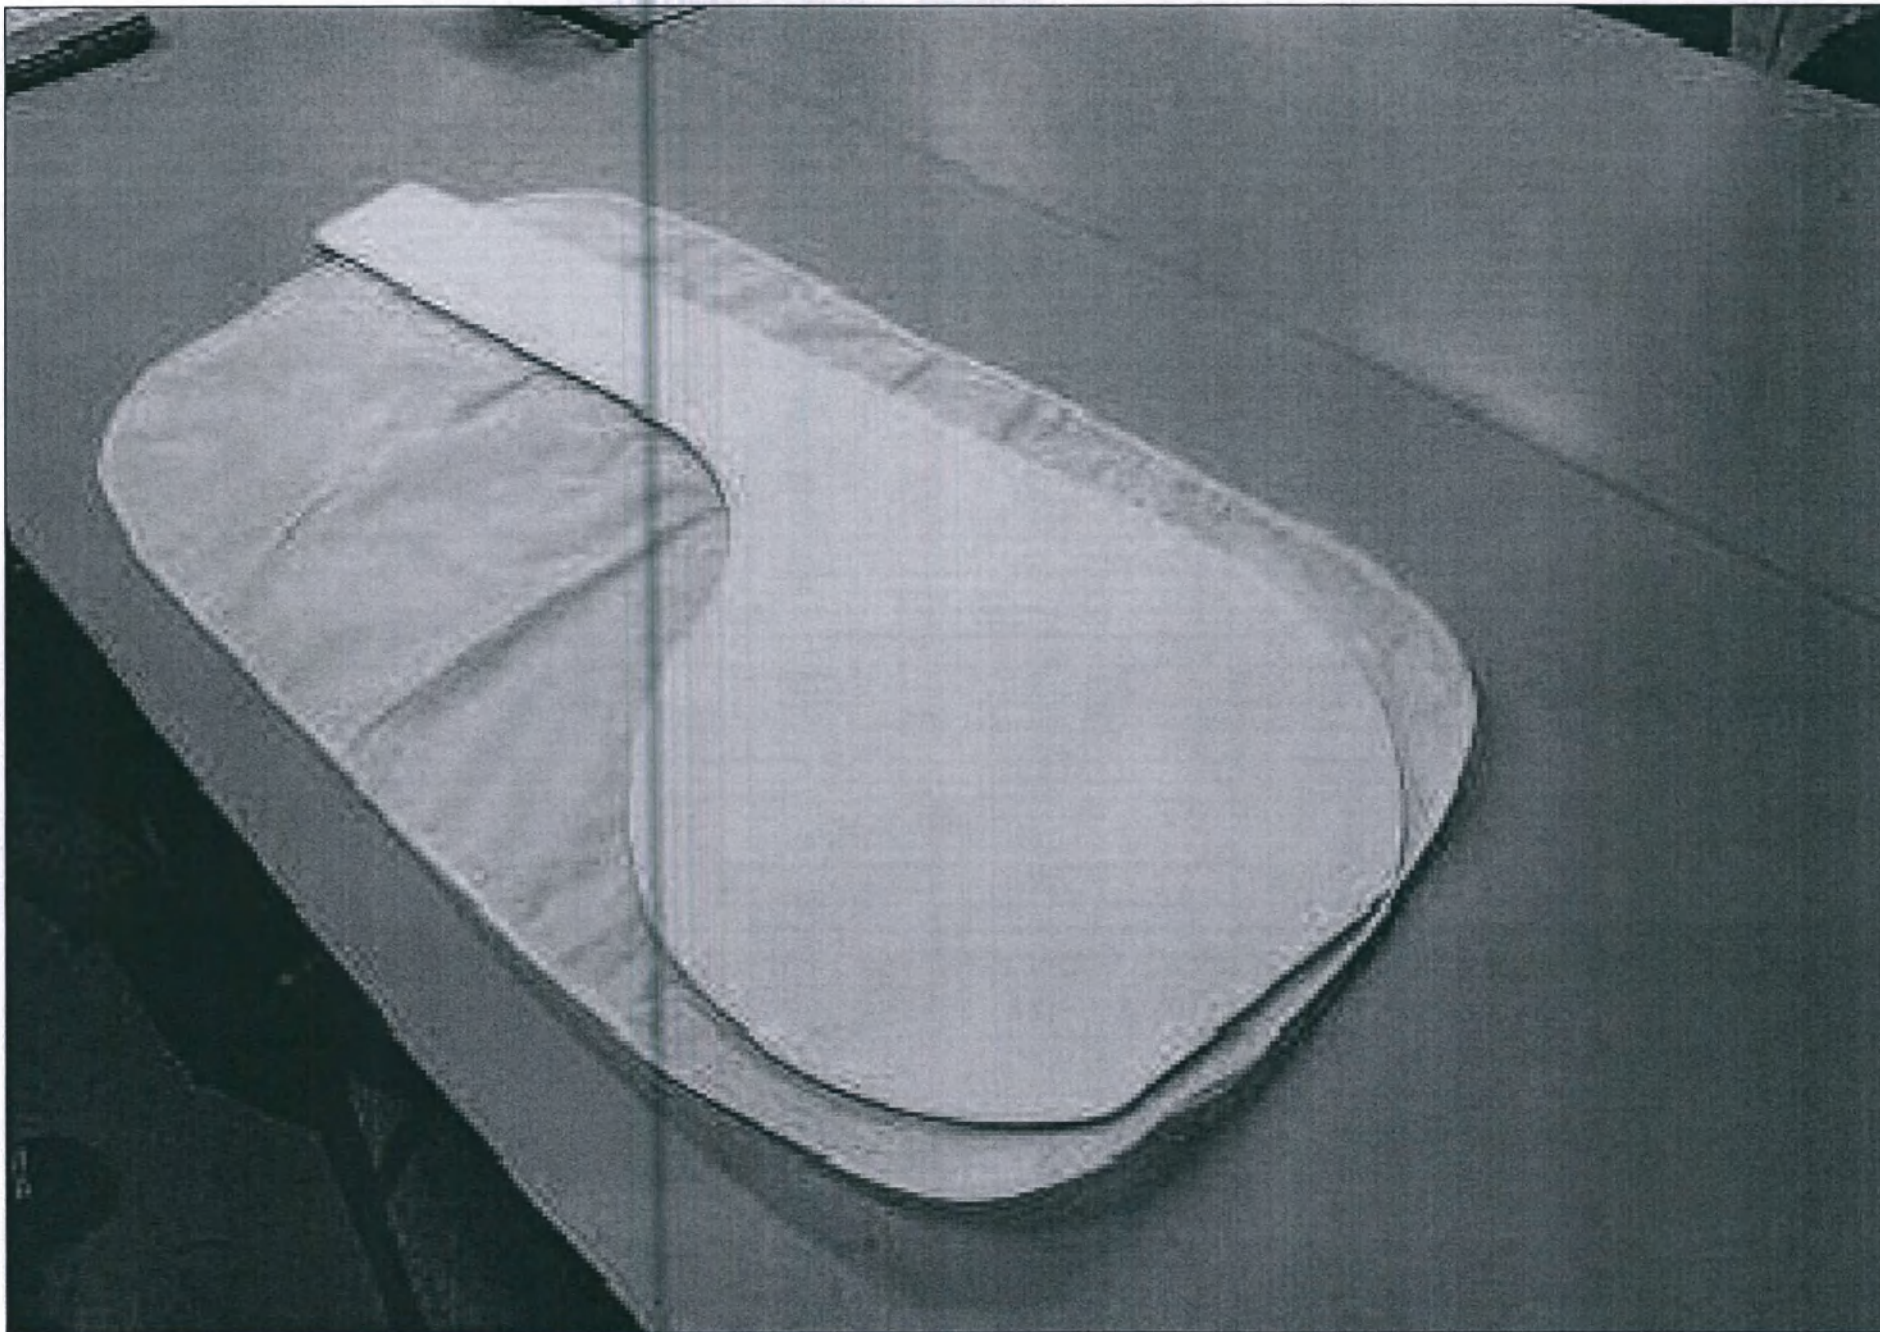

28. Опора для рук

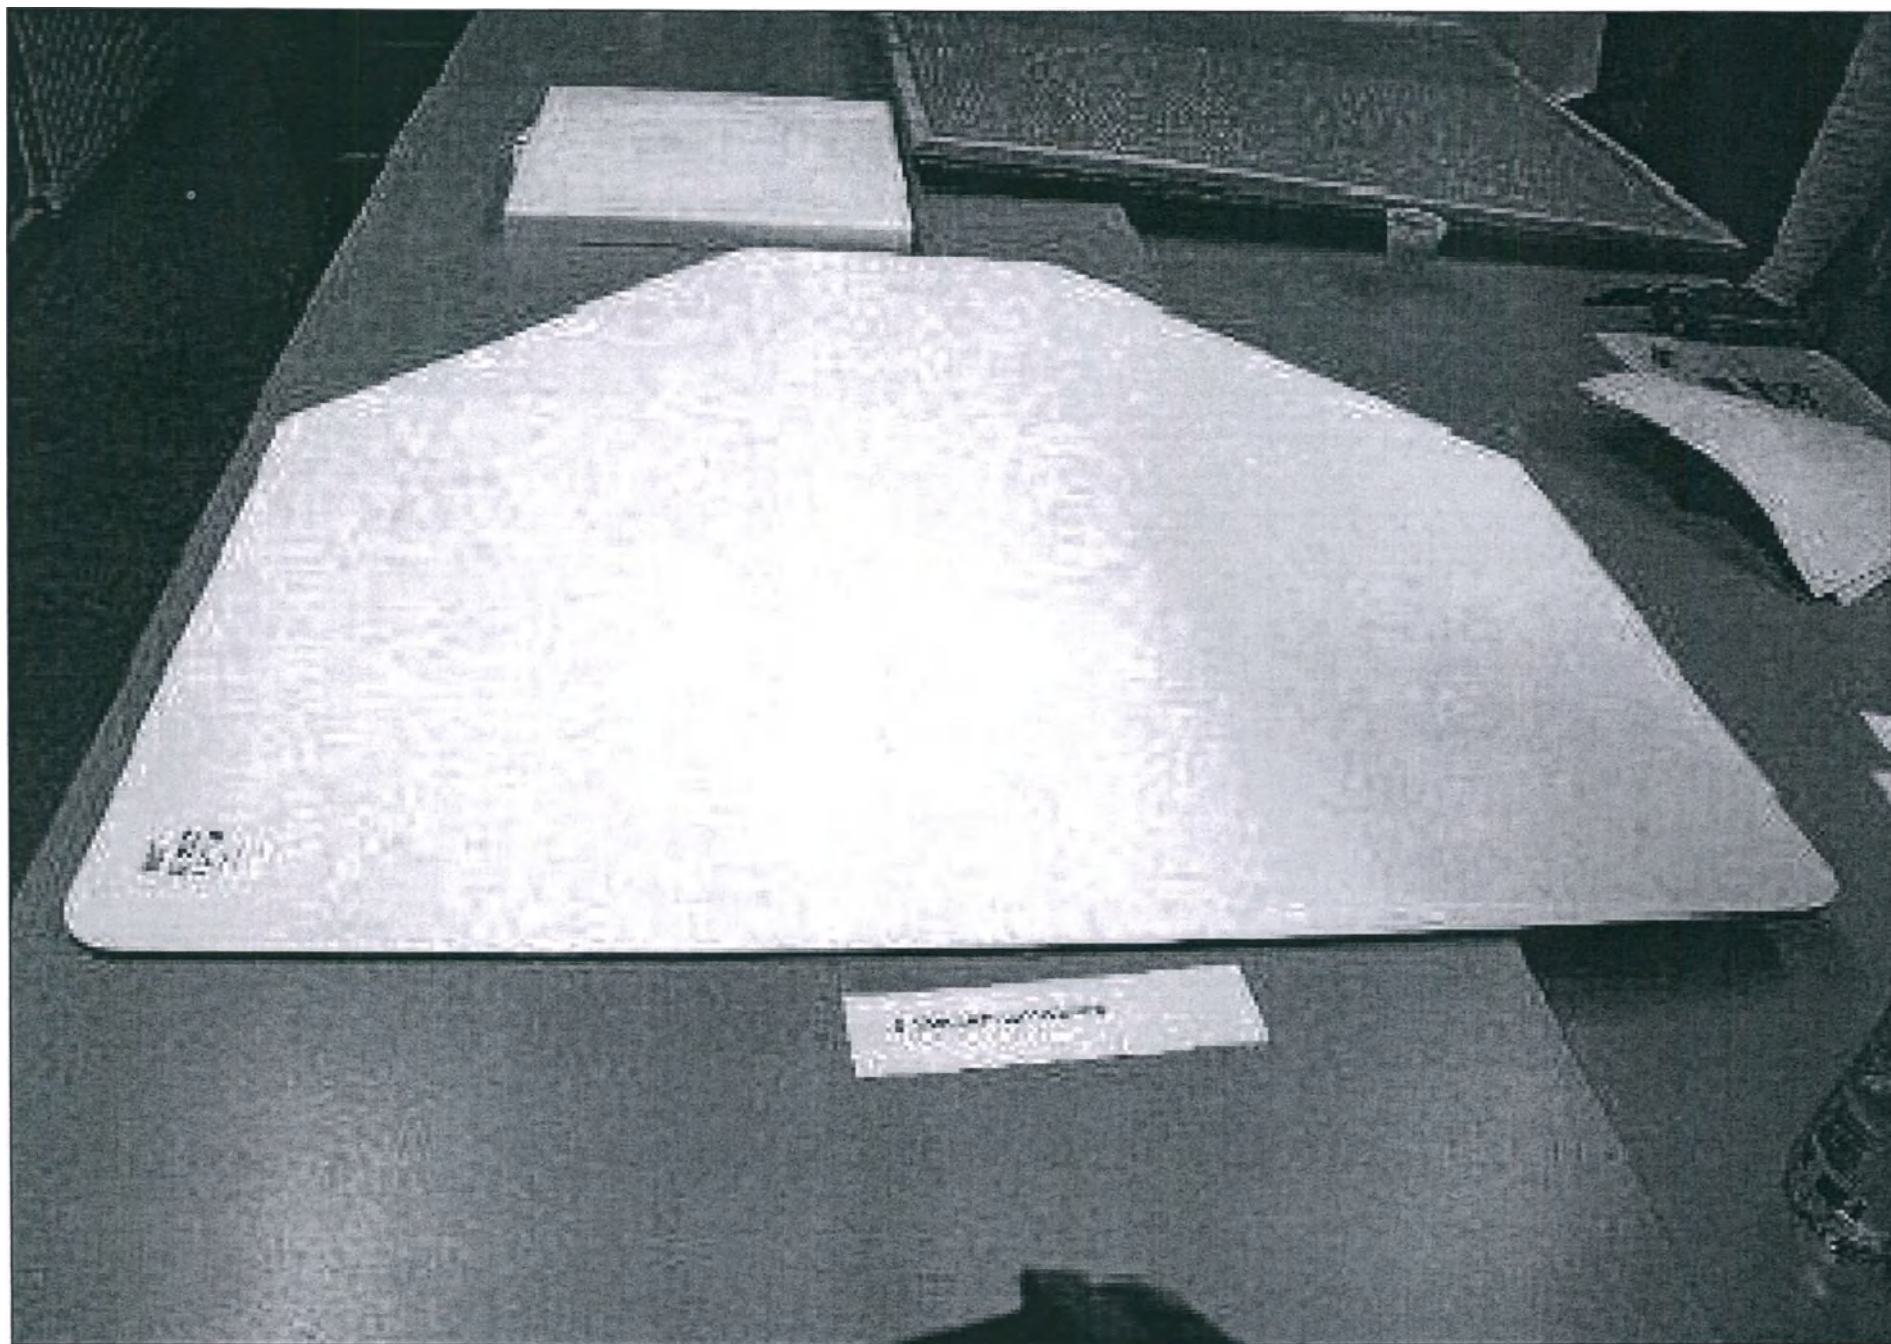

29. Опора для плеч

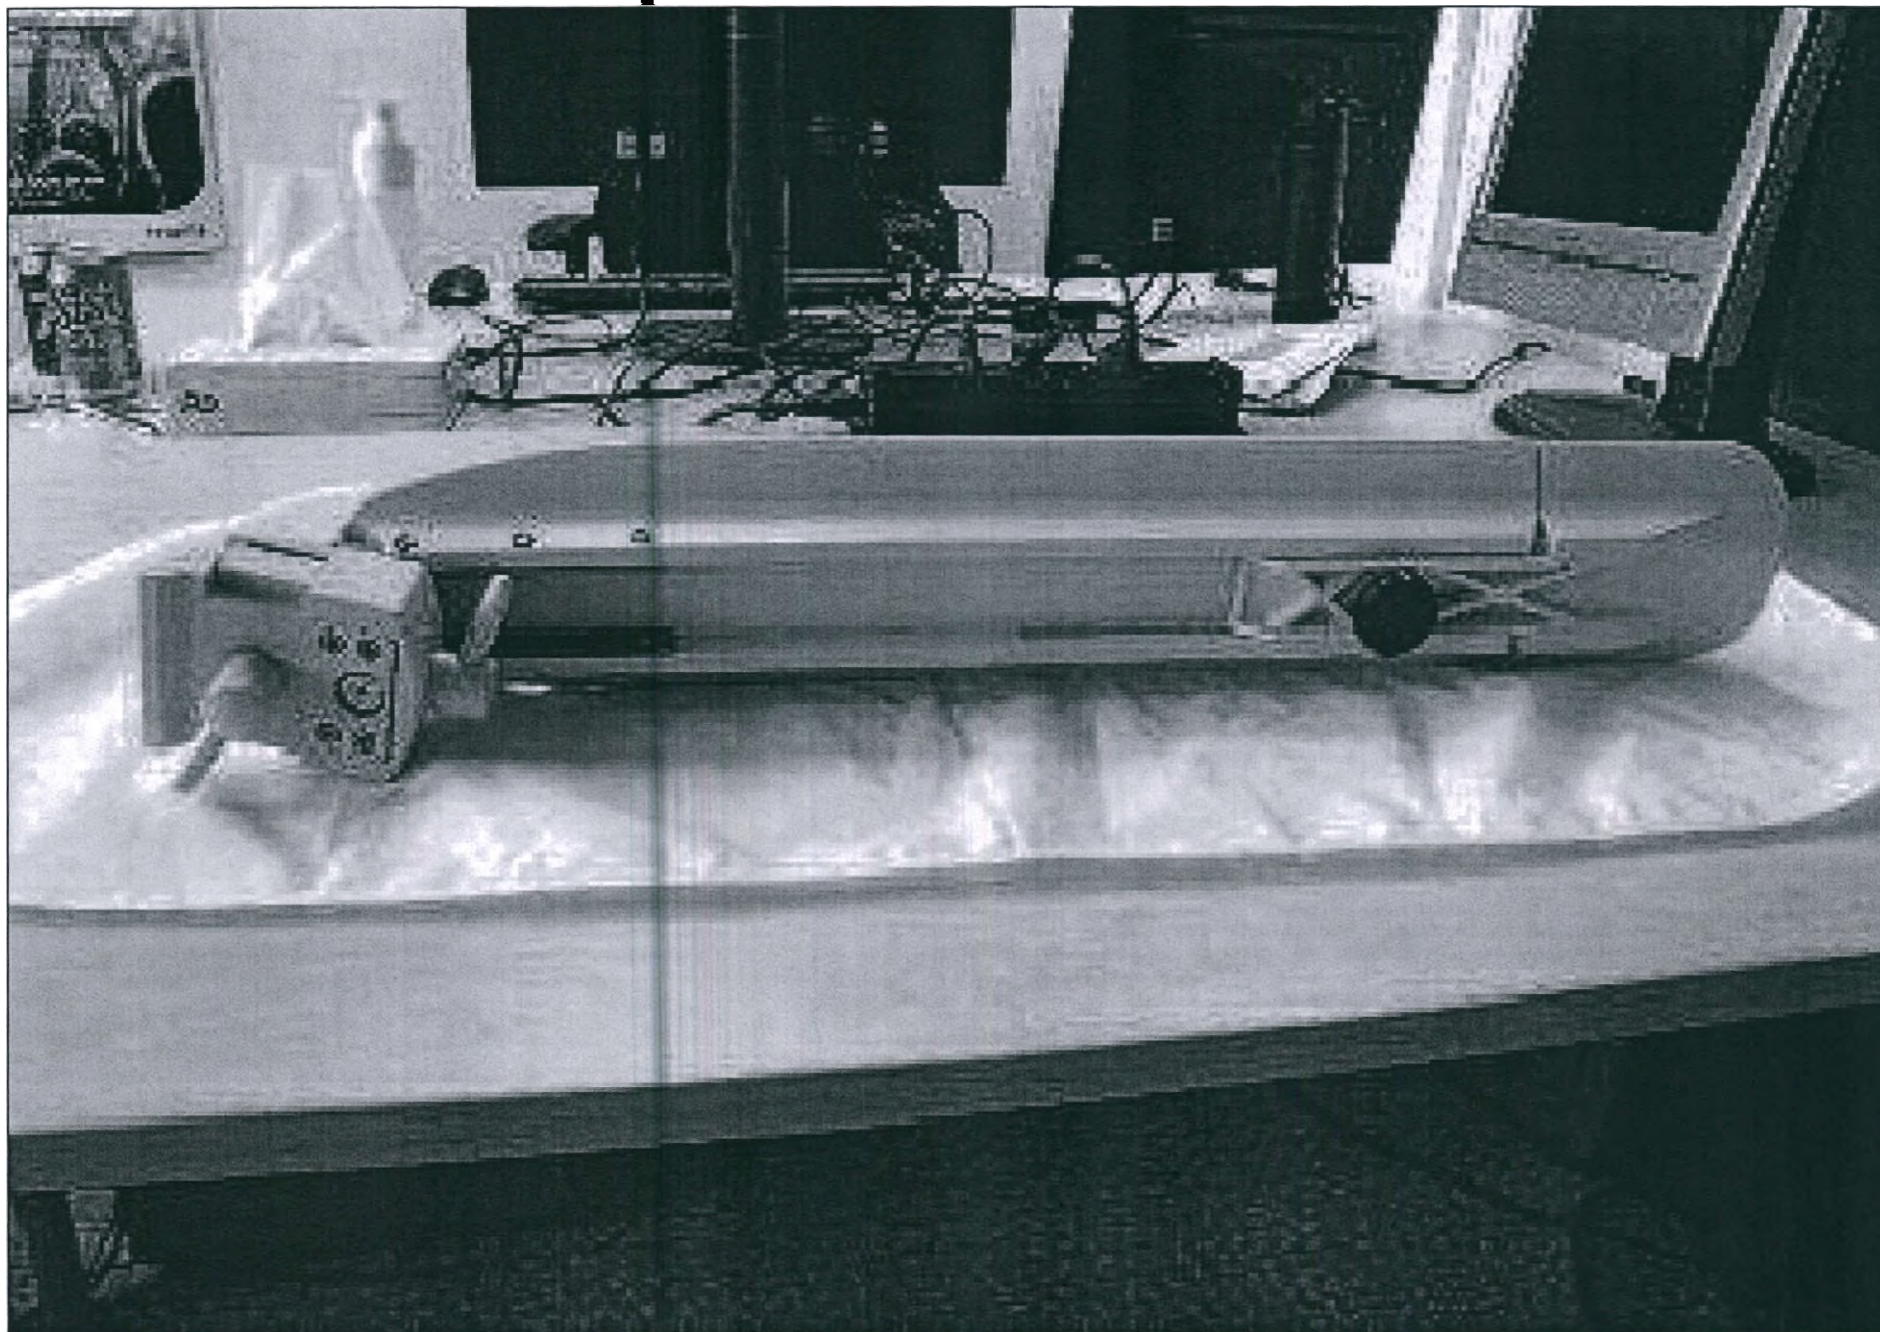


30. Опора для руки, регулируемая по высоте




31. Подголовник




32. Держатель головы для неврологических исследований.

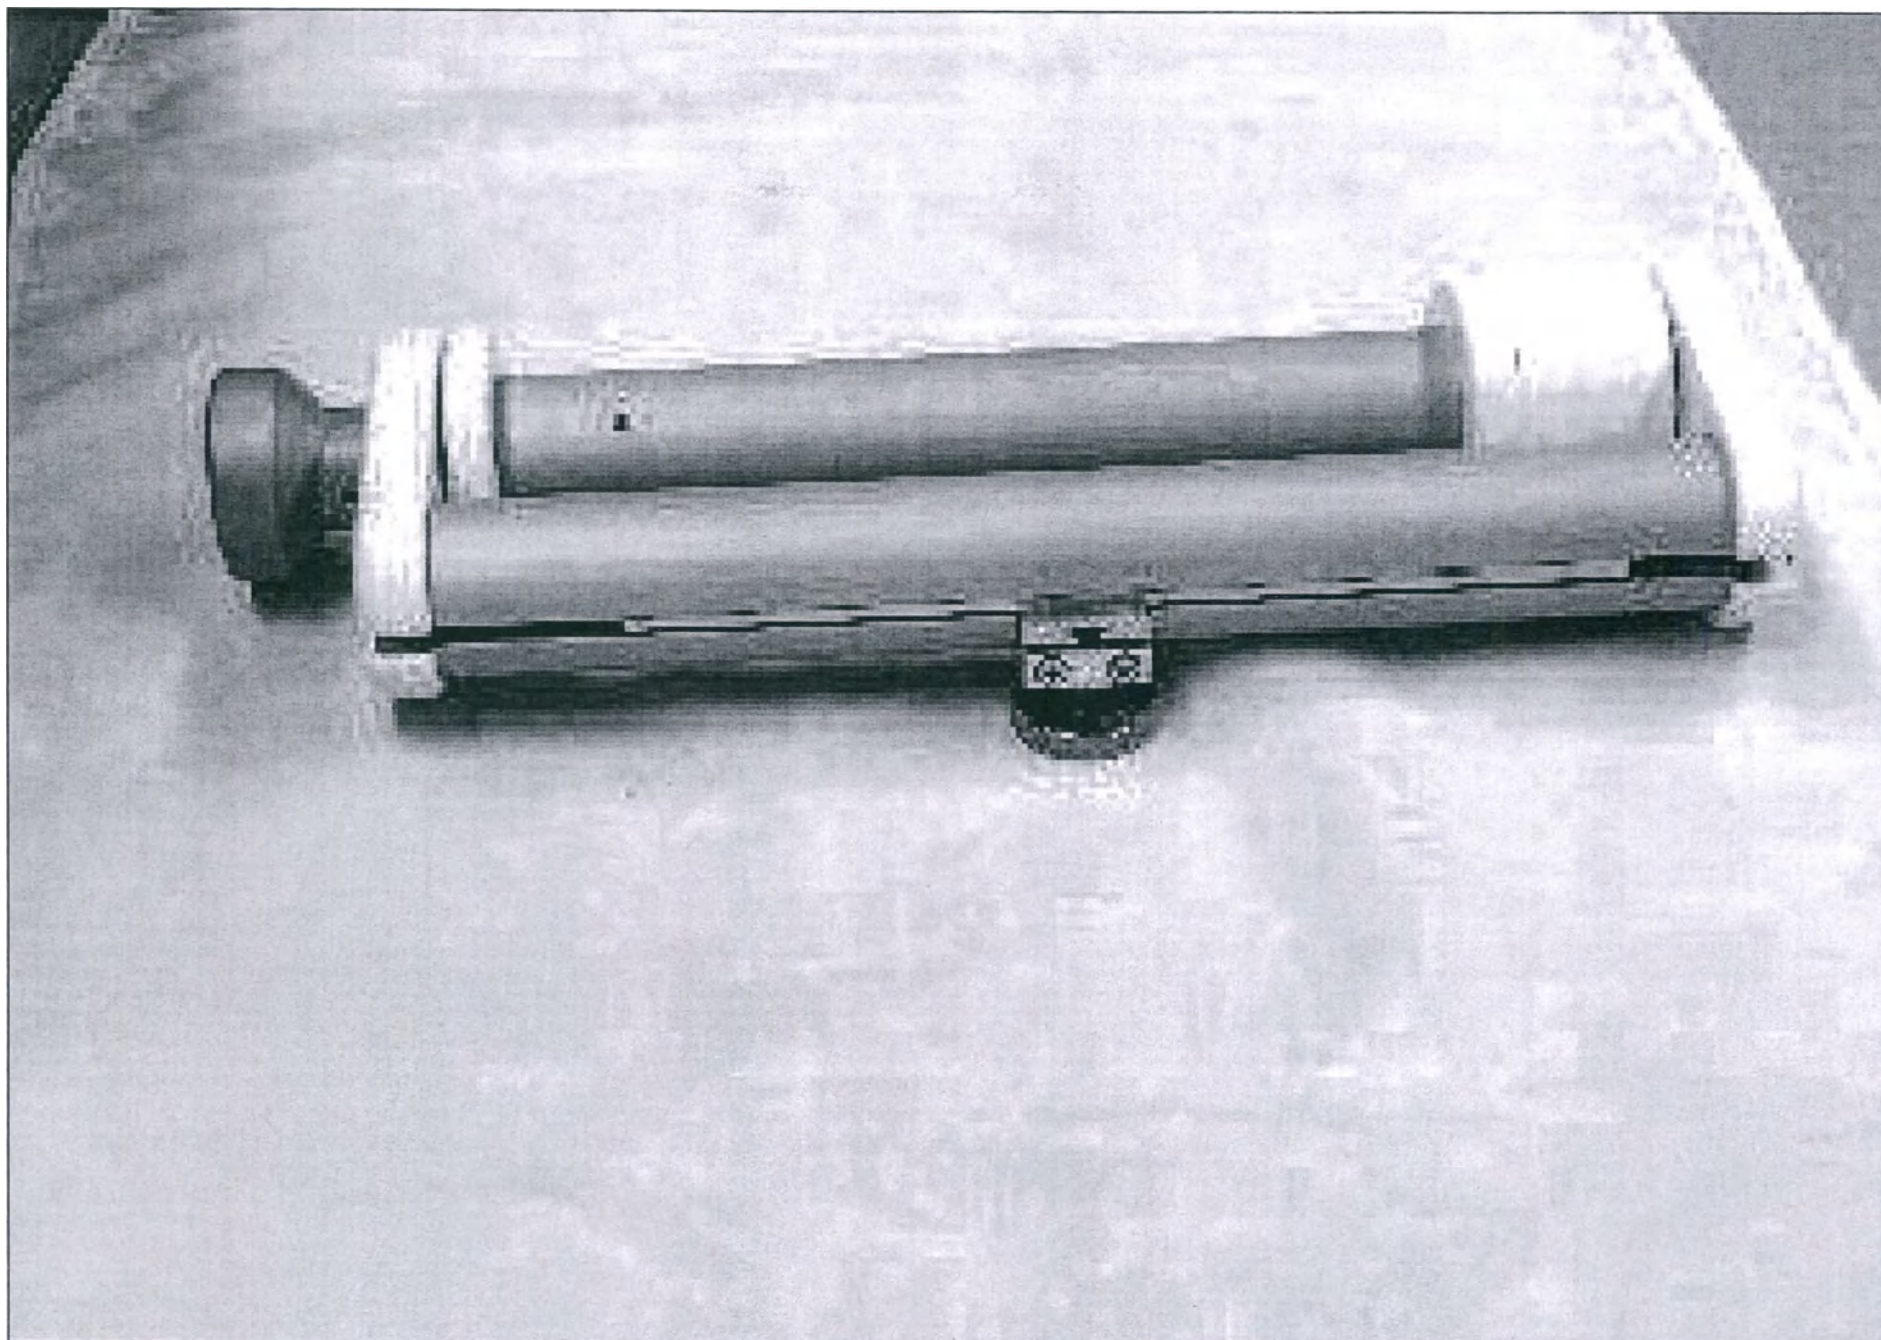


33. Компрессионный зажим с храповым механизмом.

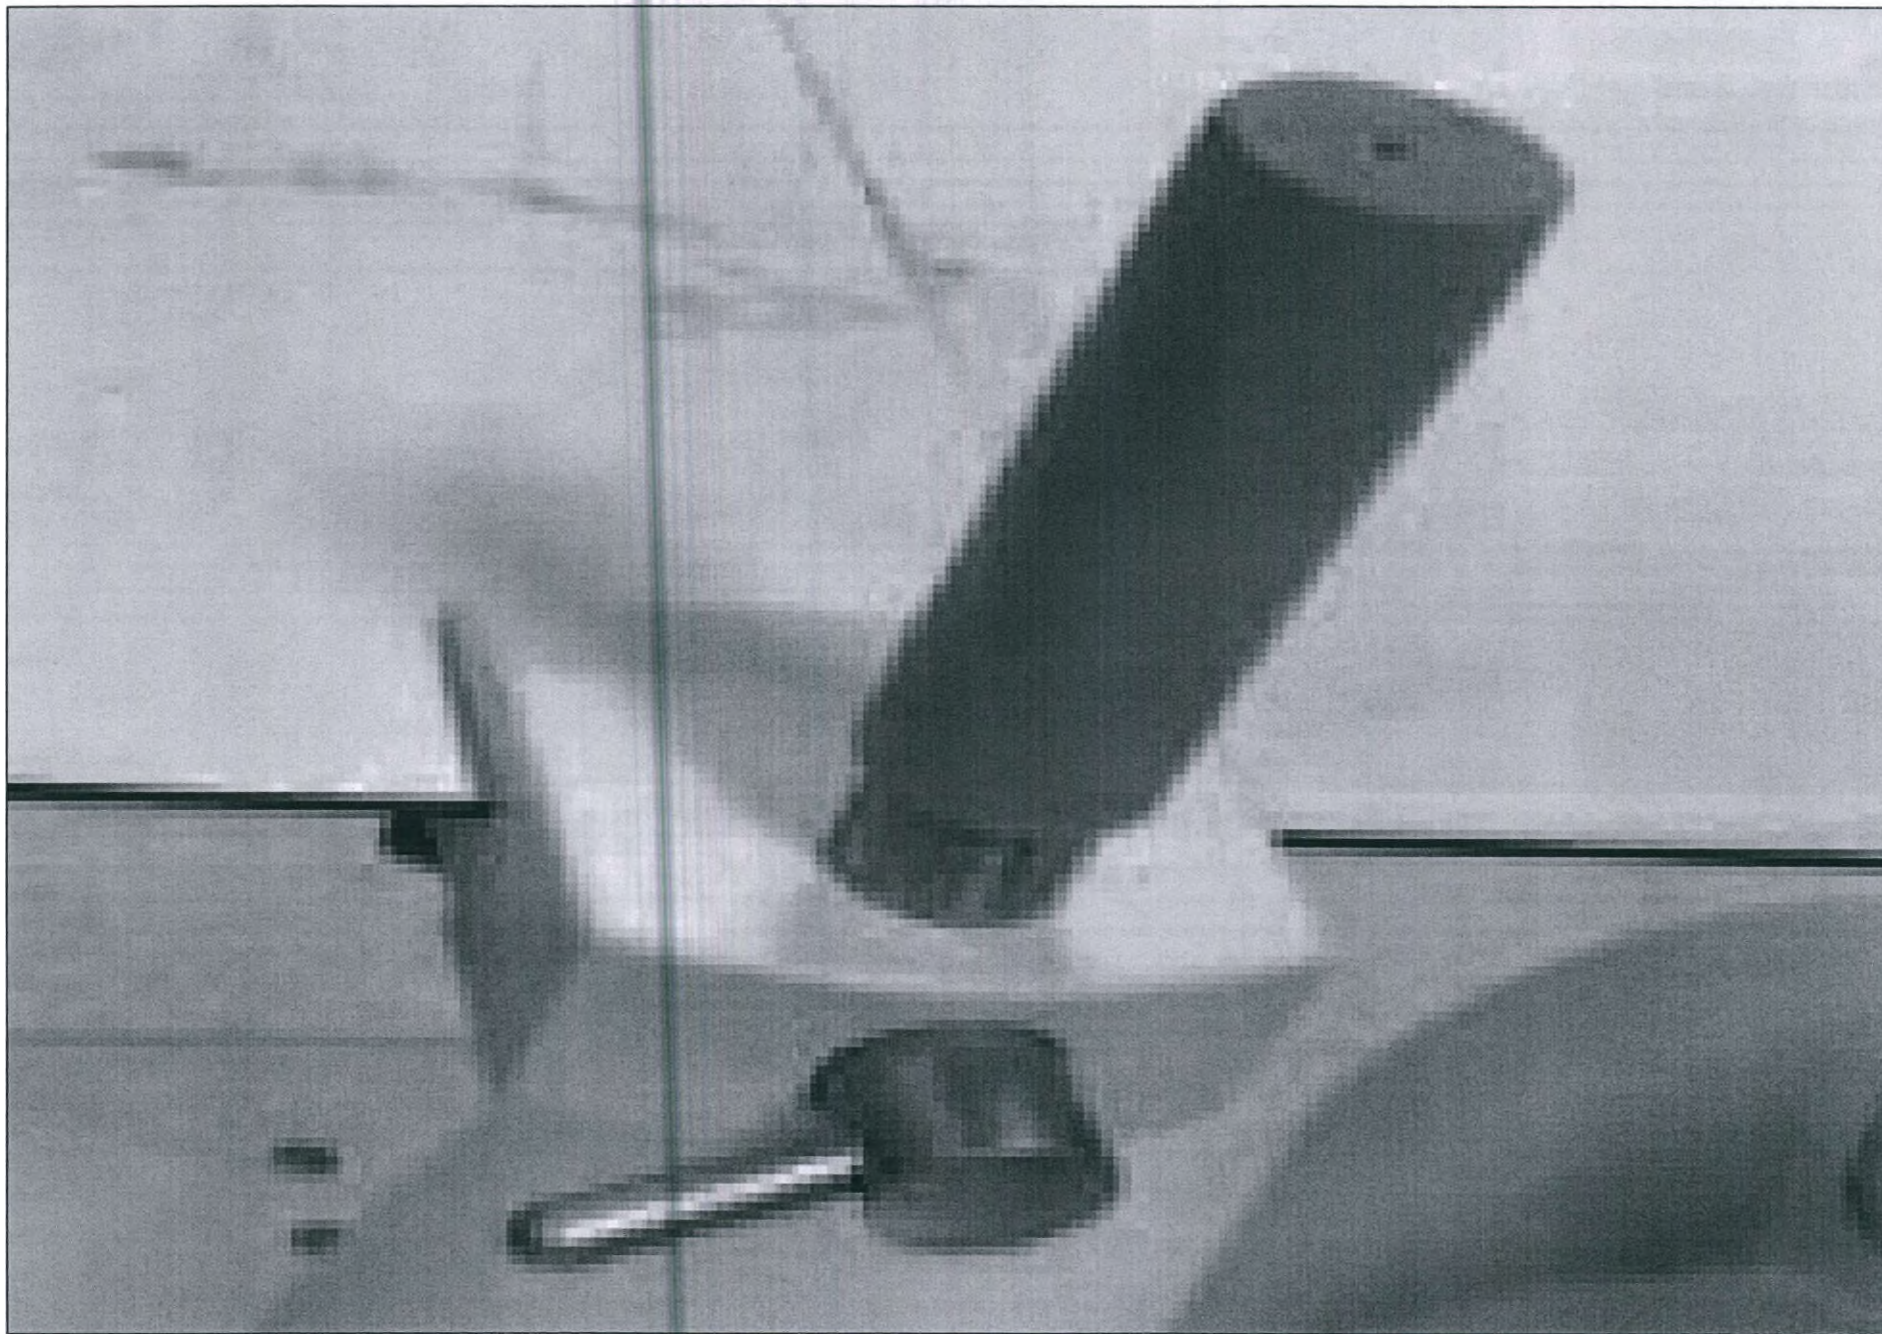


34. Набор рукояток и зажимов

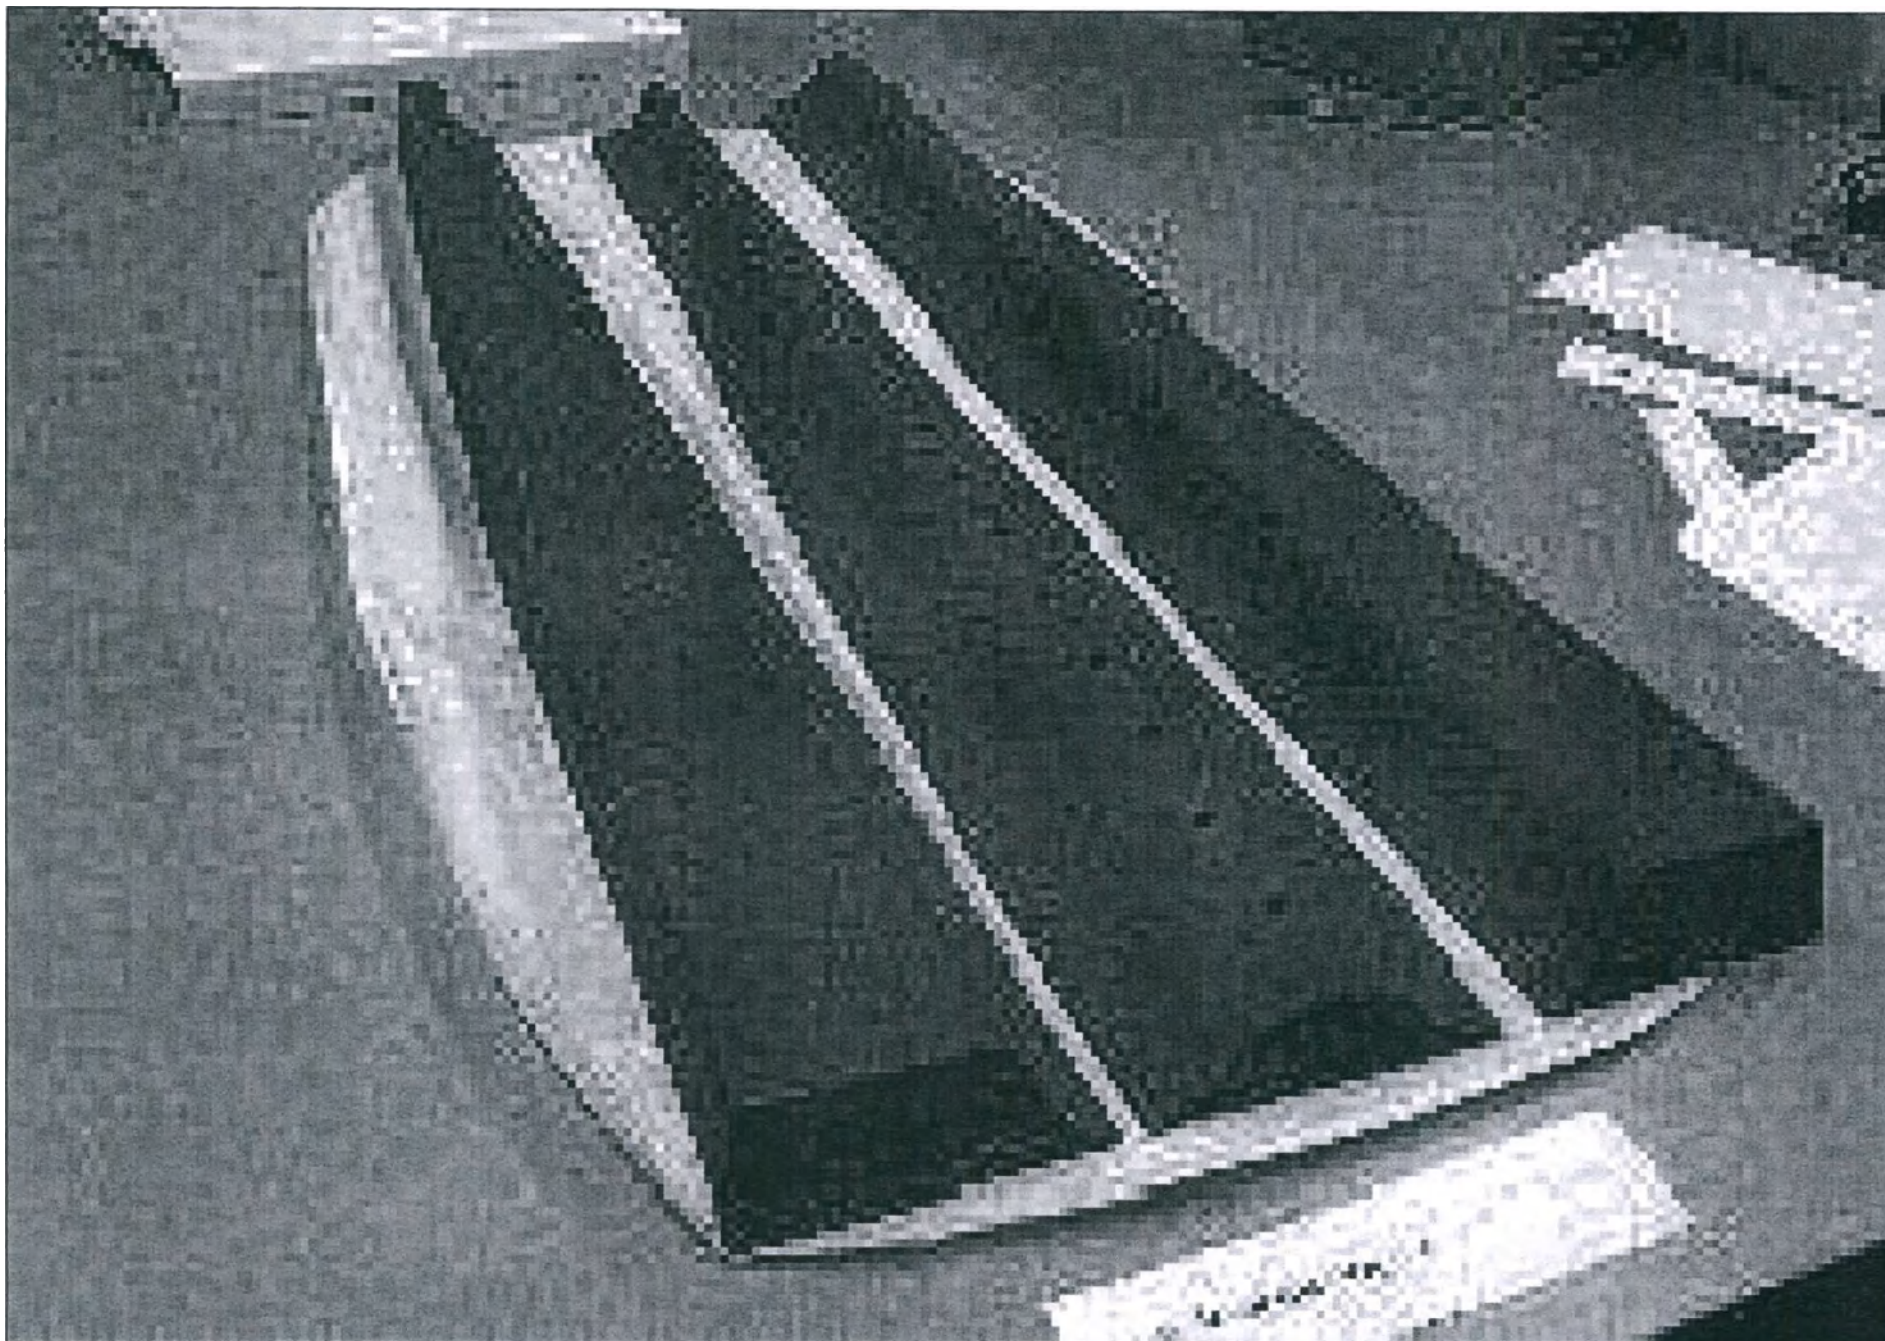


35. Периферические рентгеновские фильтры

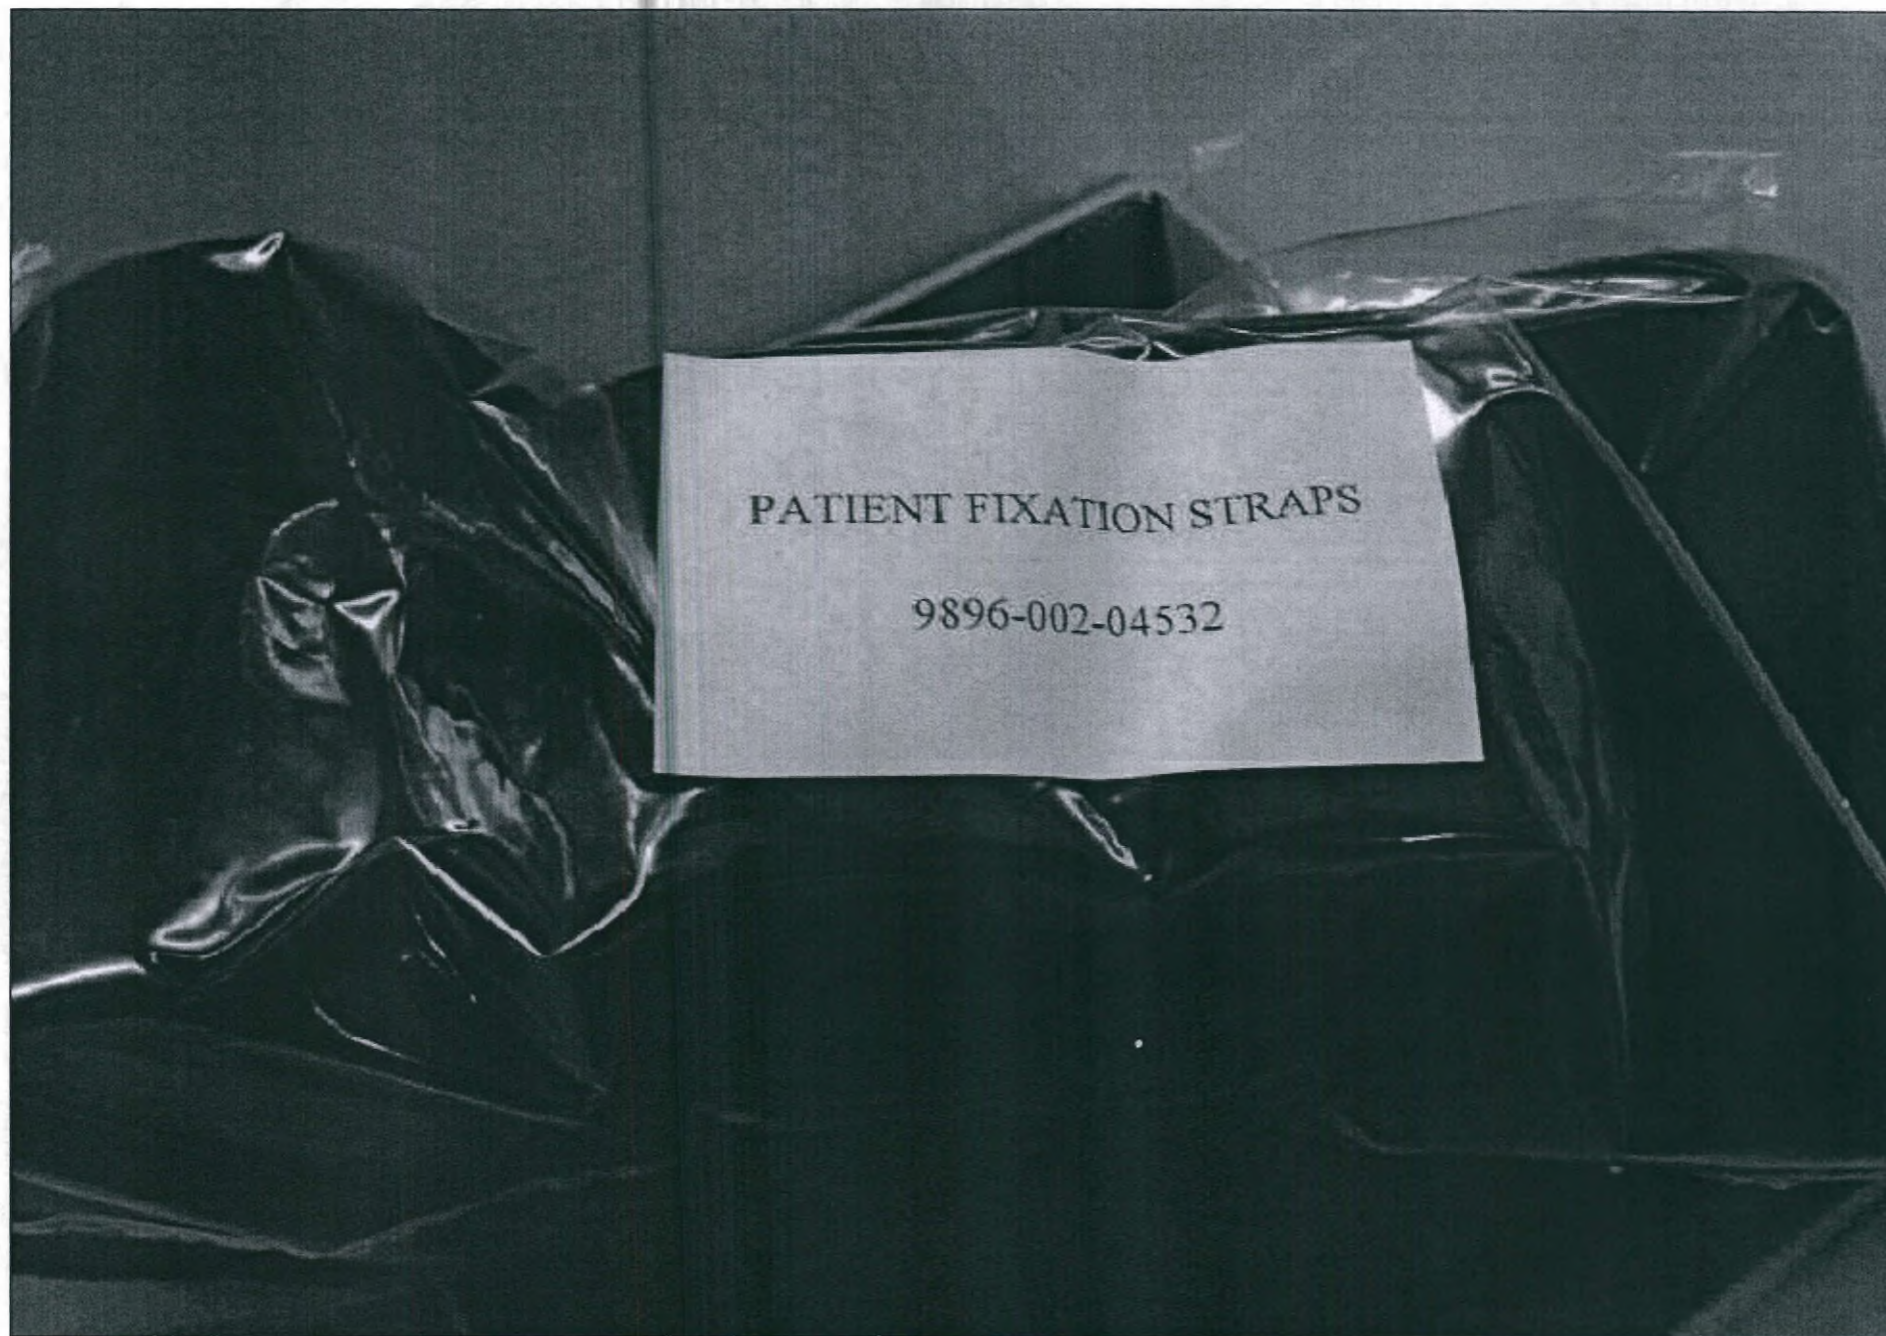


36. Ремни для фиксации положения пациента

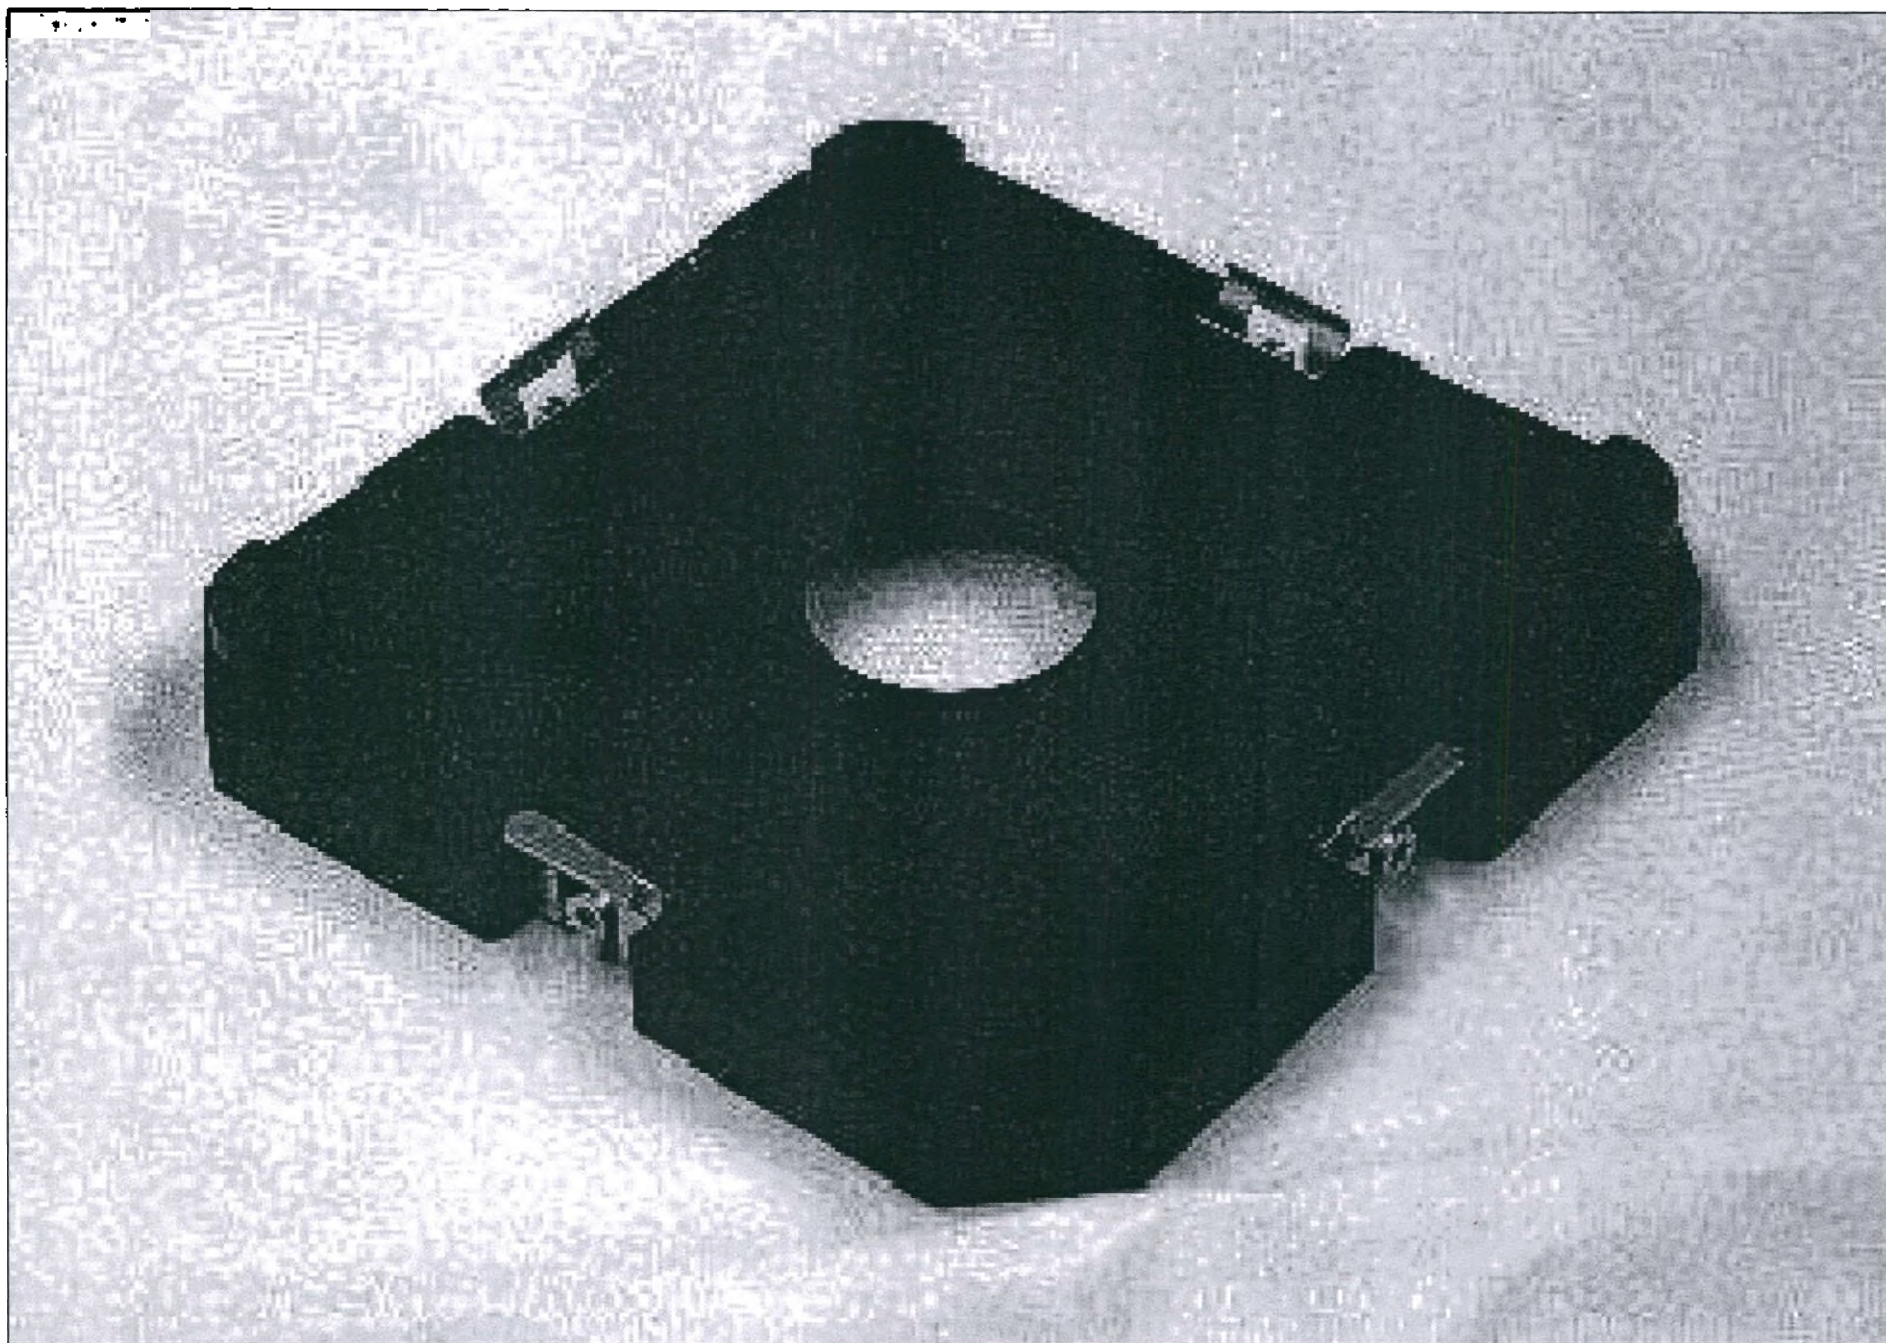

37. Церебральный фильтр

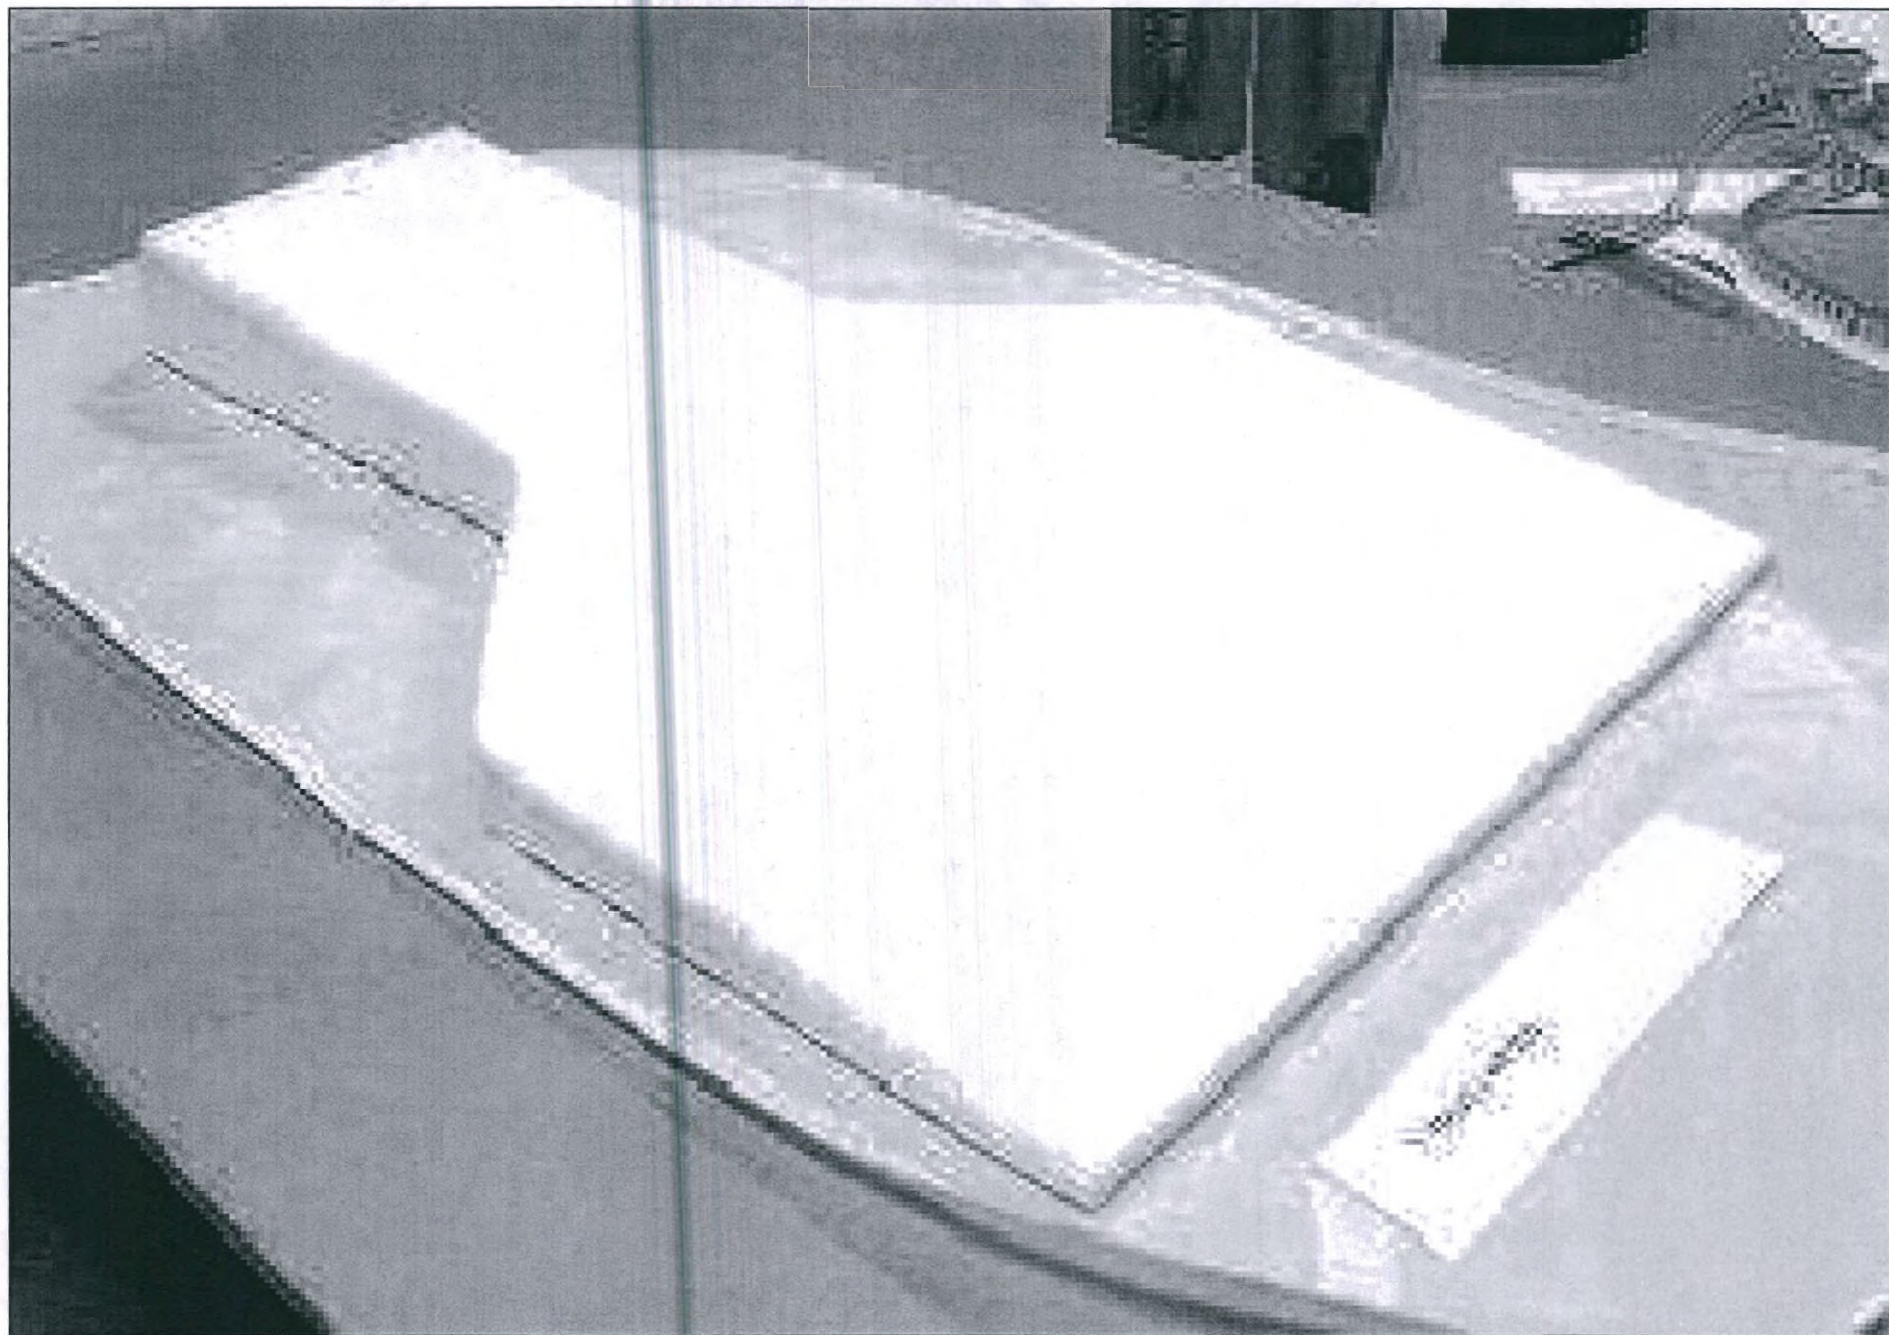


38. Клин для неврологических исследований.

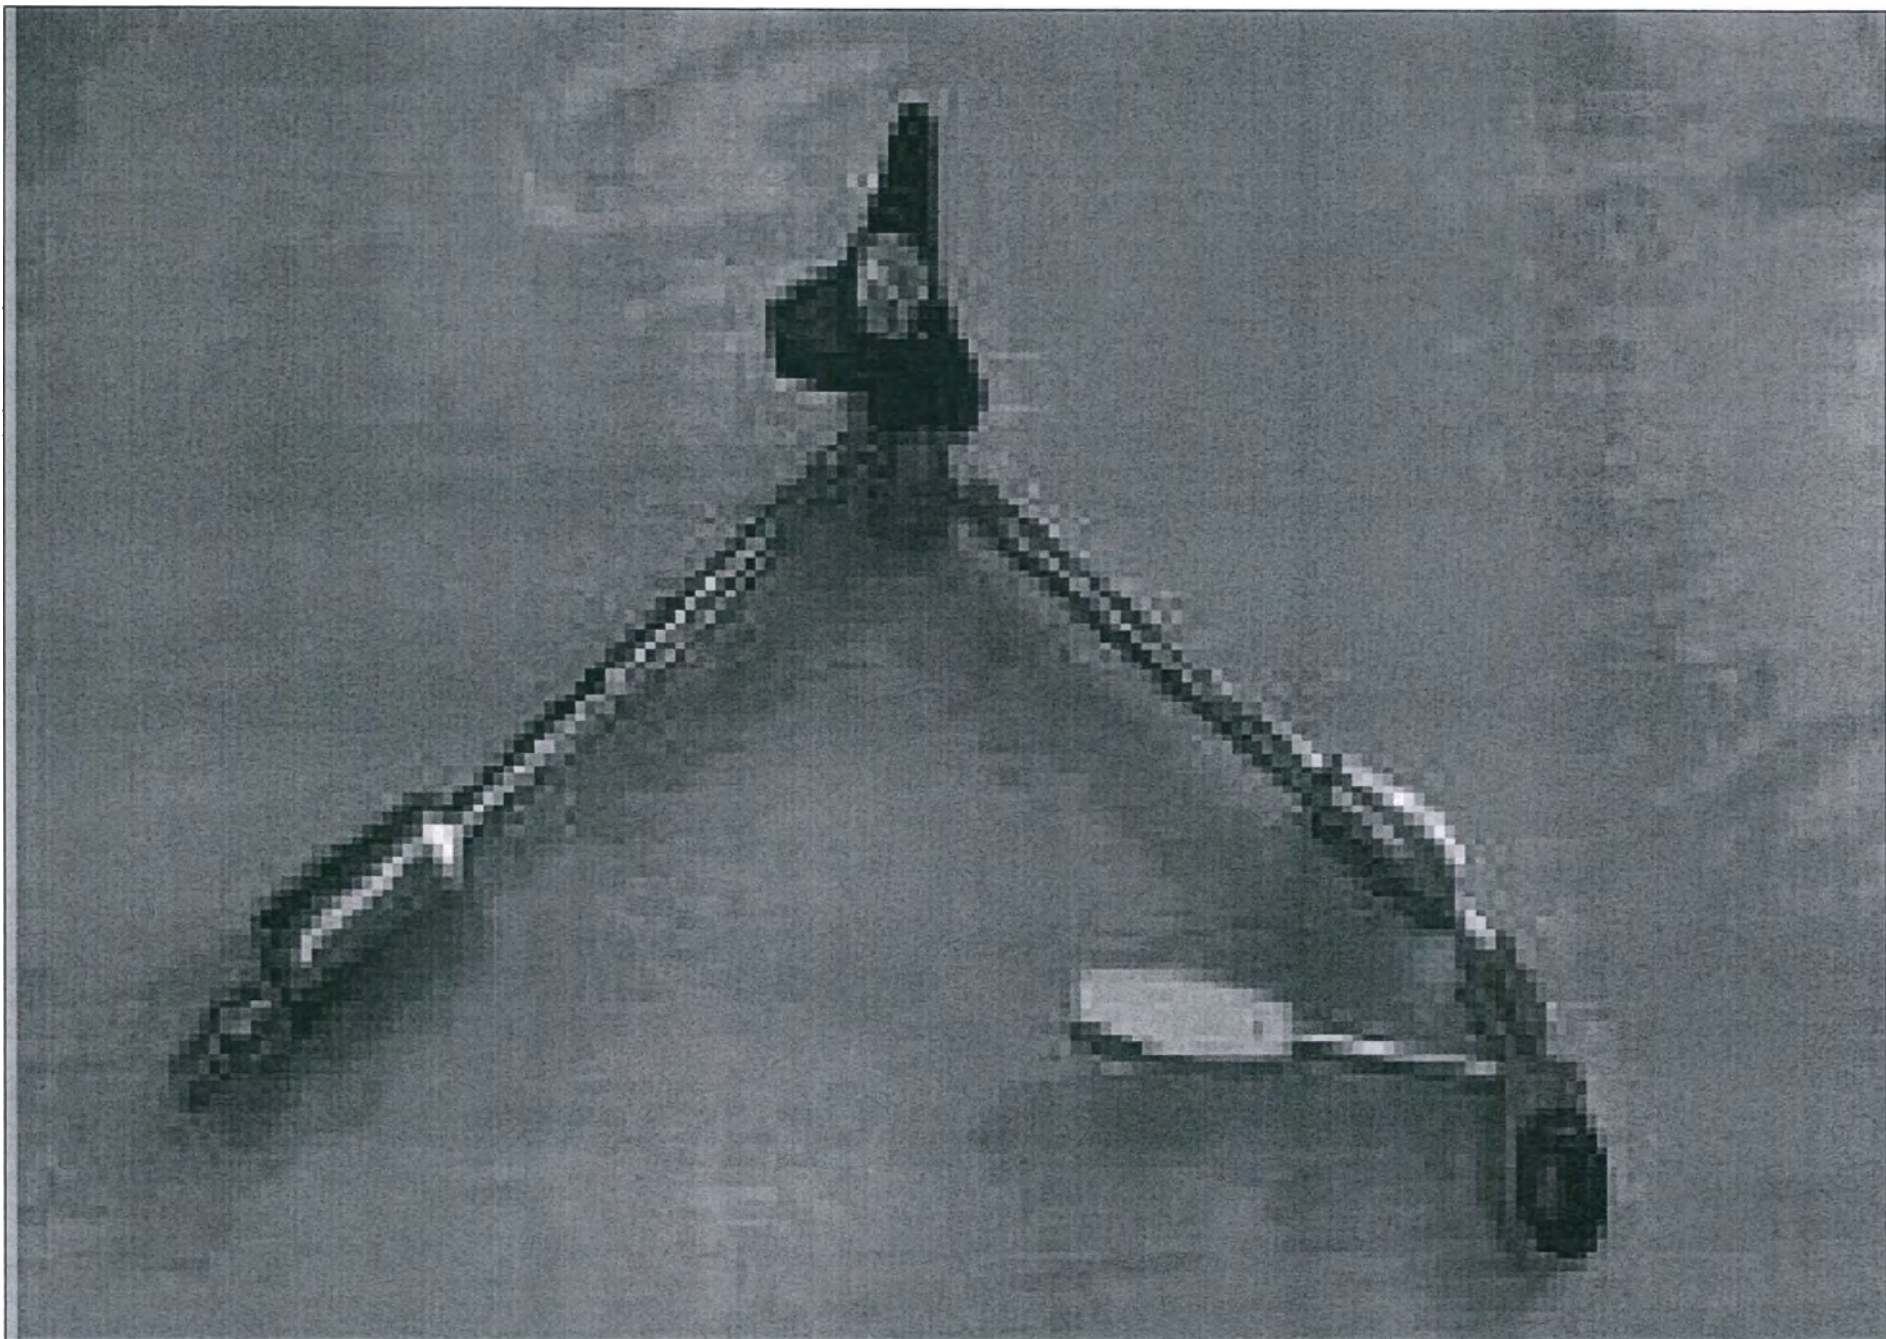


39. Держатели специальные




40. Стандартный матрас.

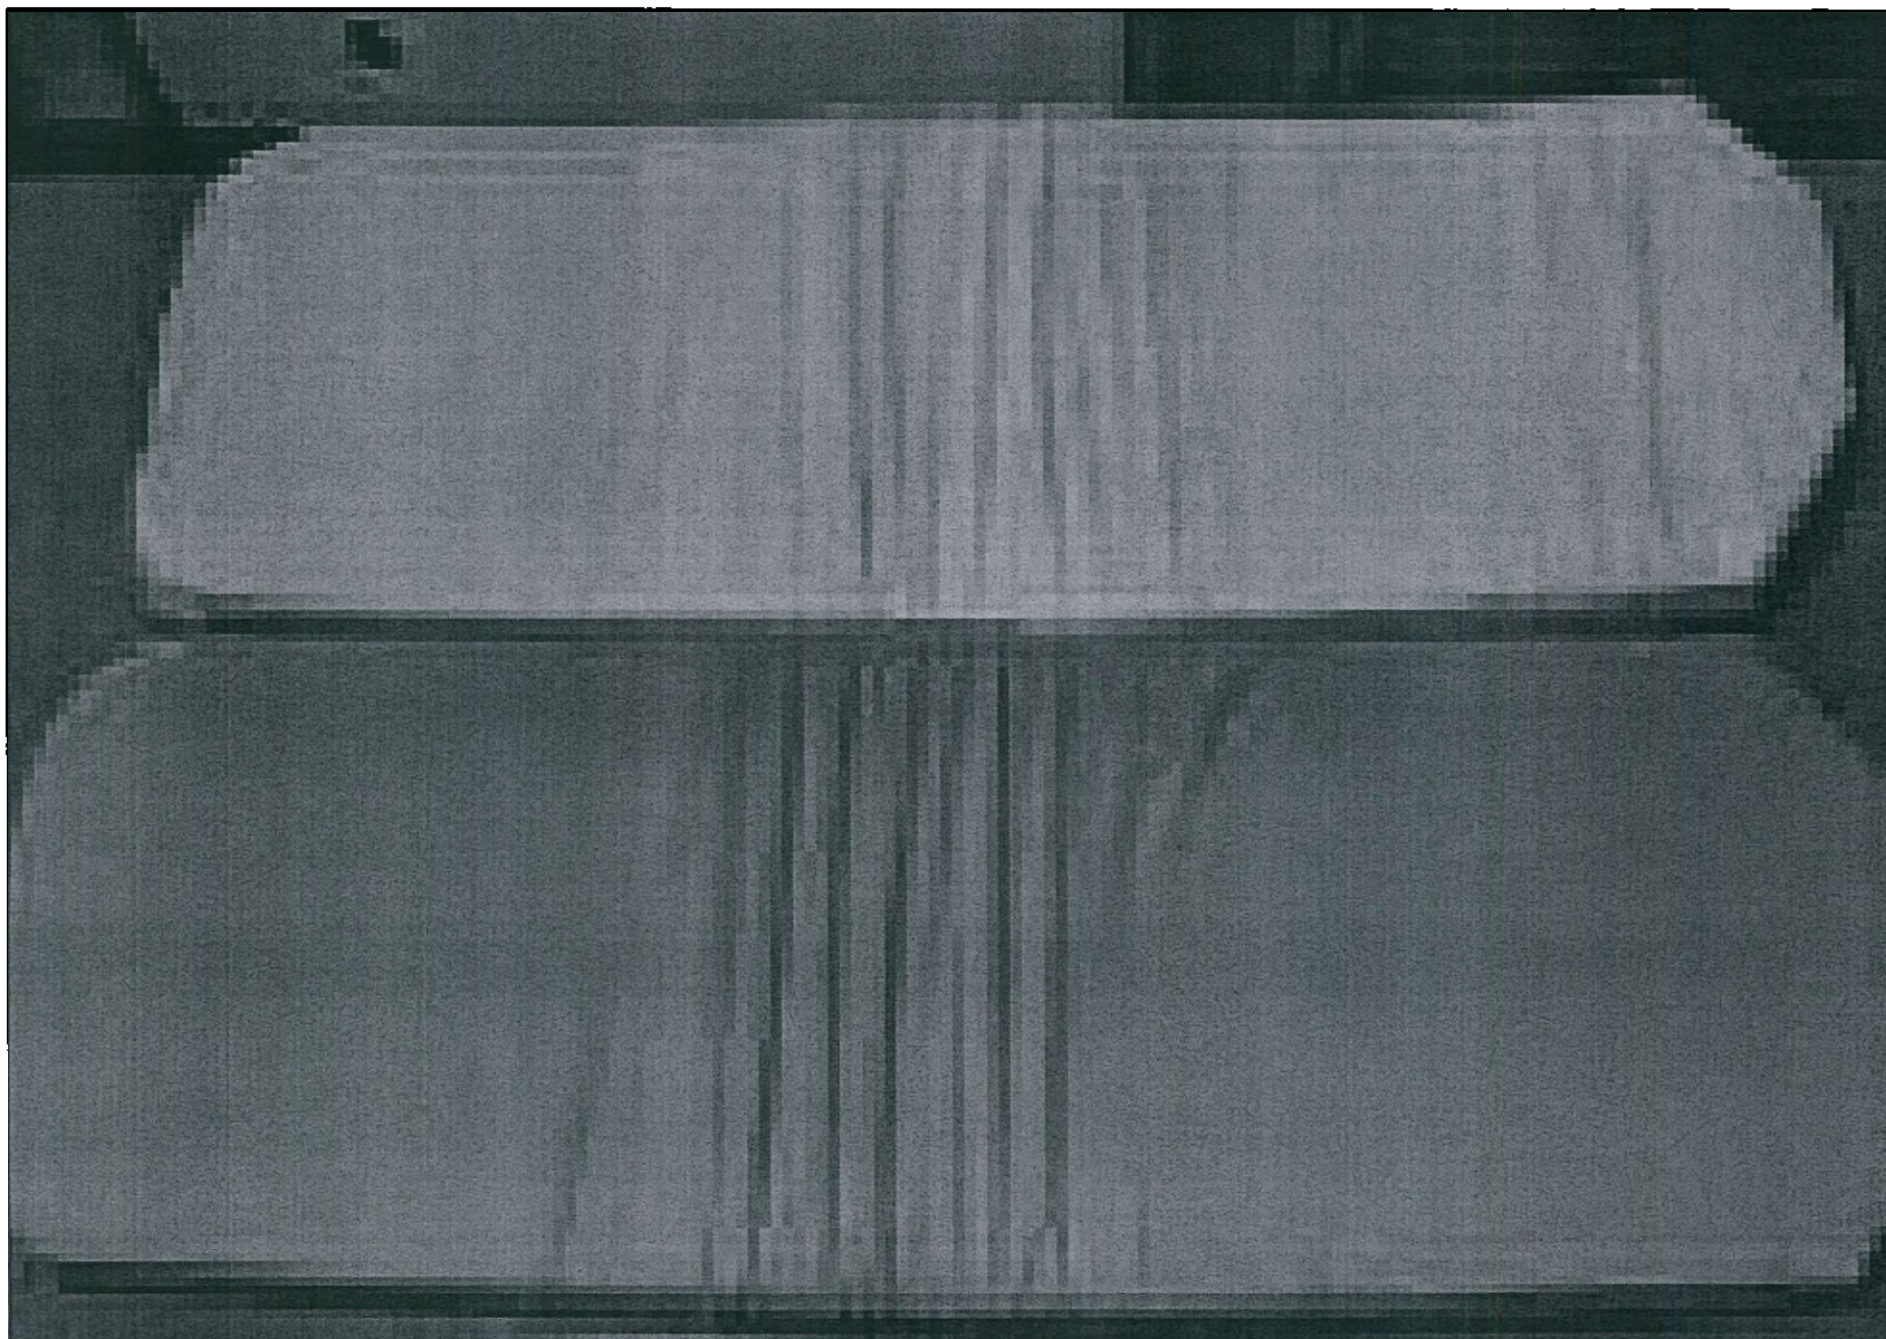


41. Матрас для кардиологических исследований.

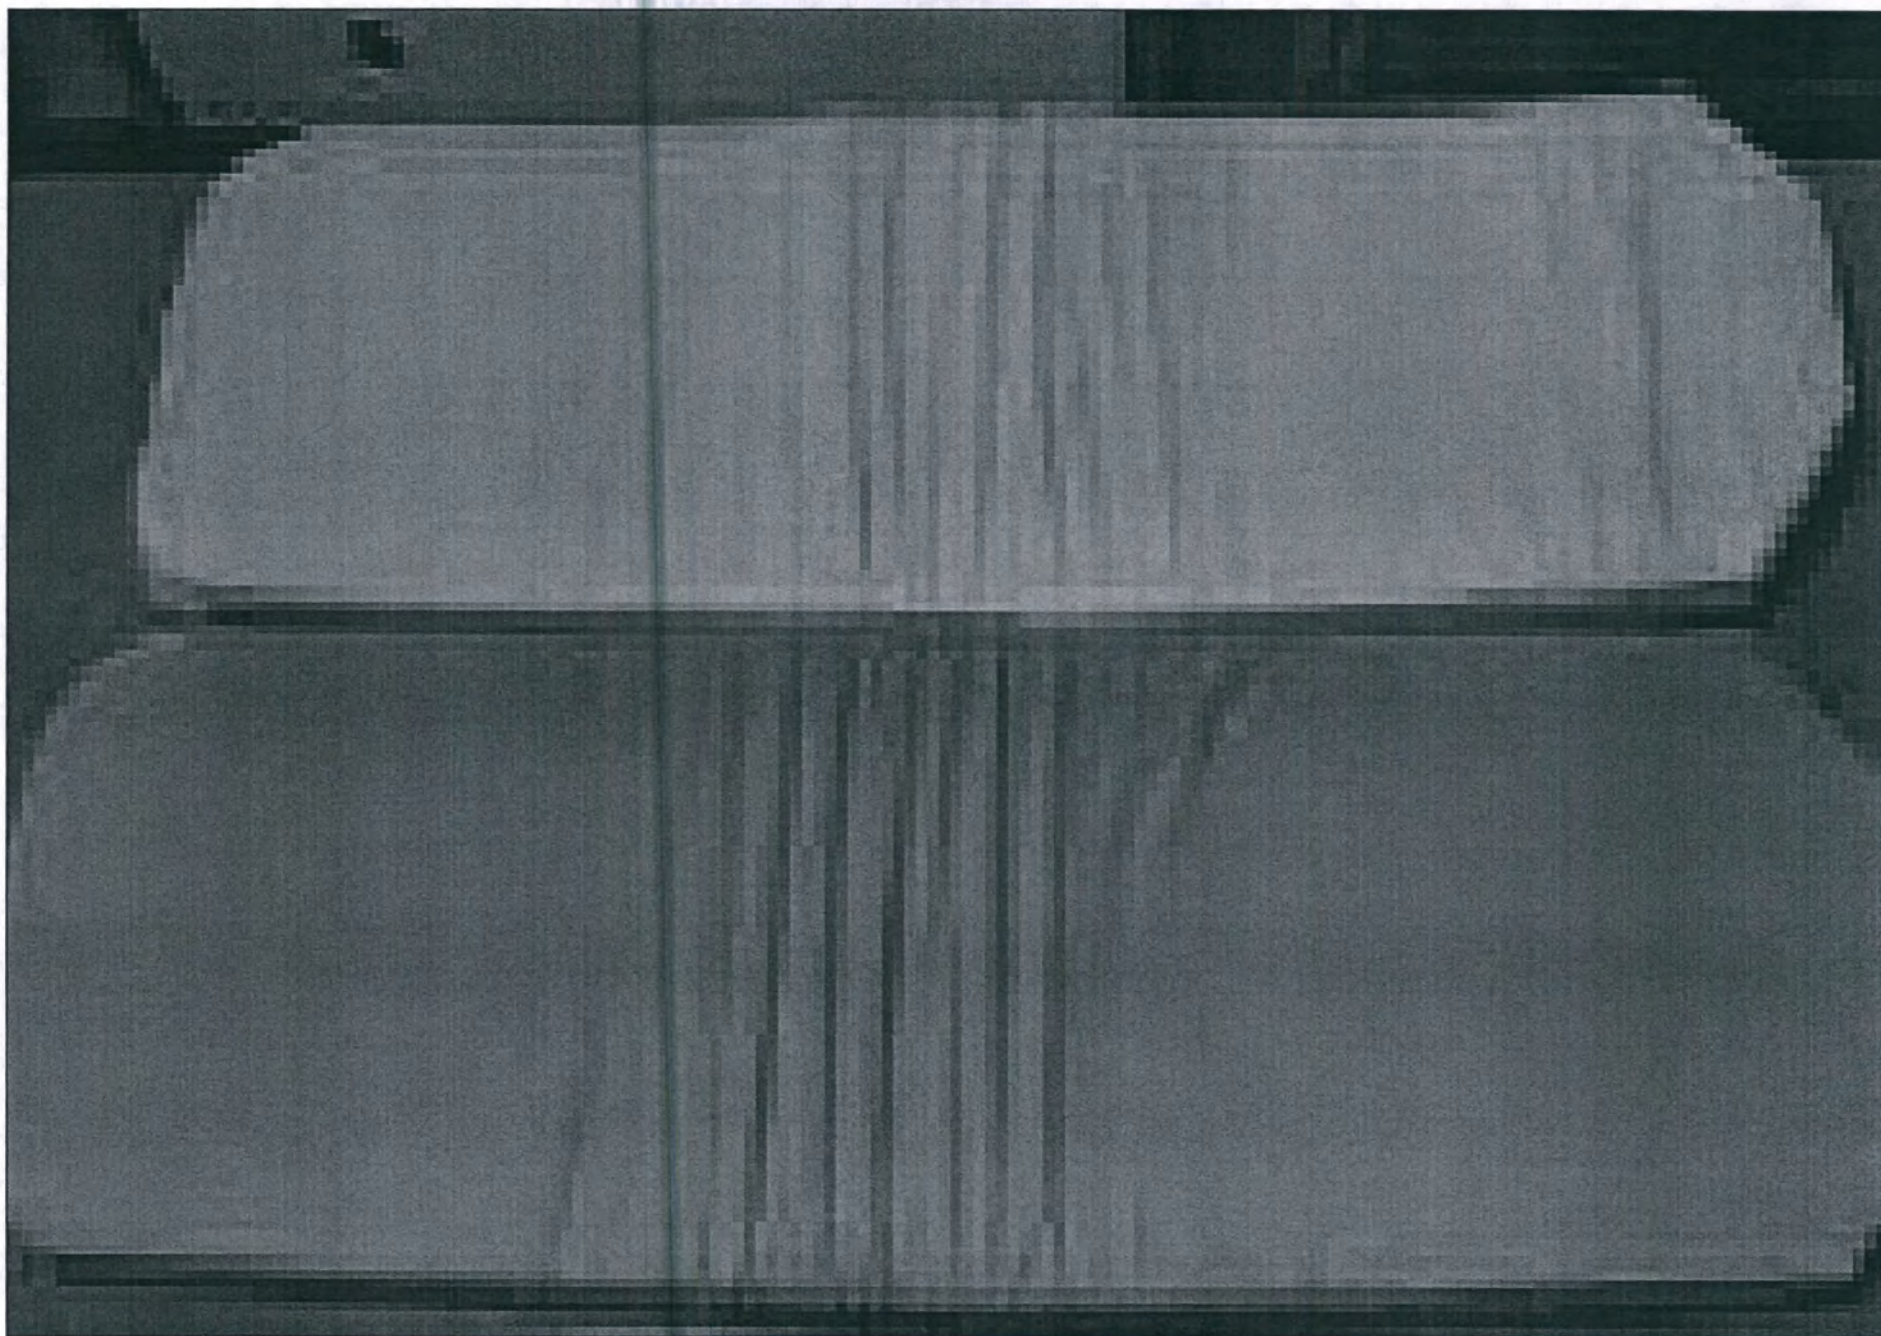


42. Матрас для неврологических исследований

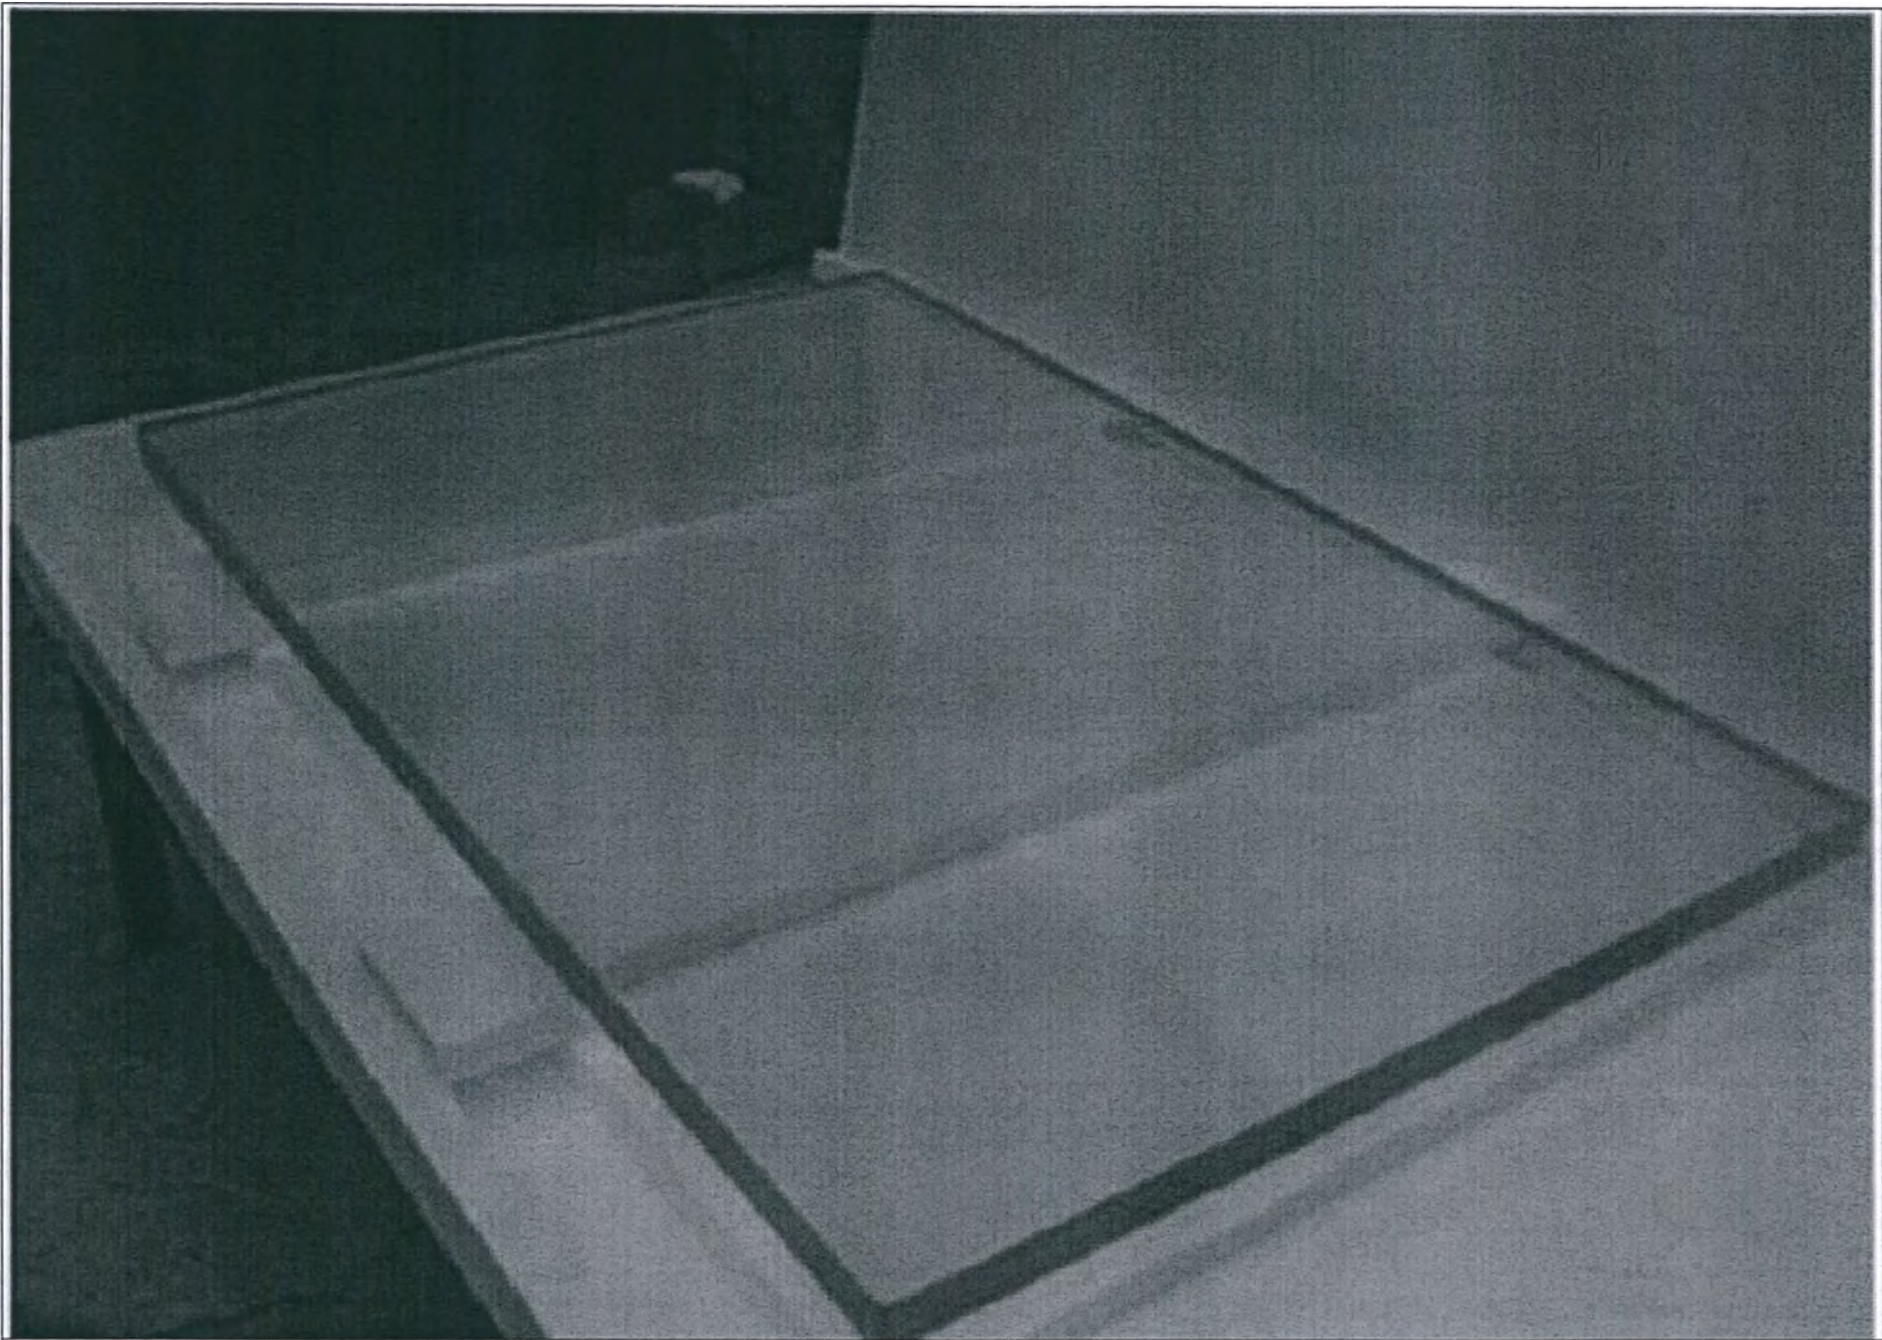


43. Экран радиационной защиты

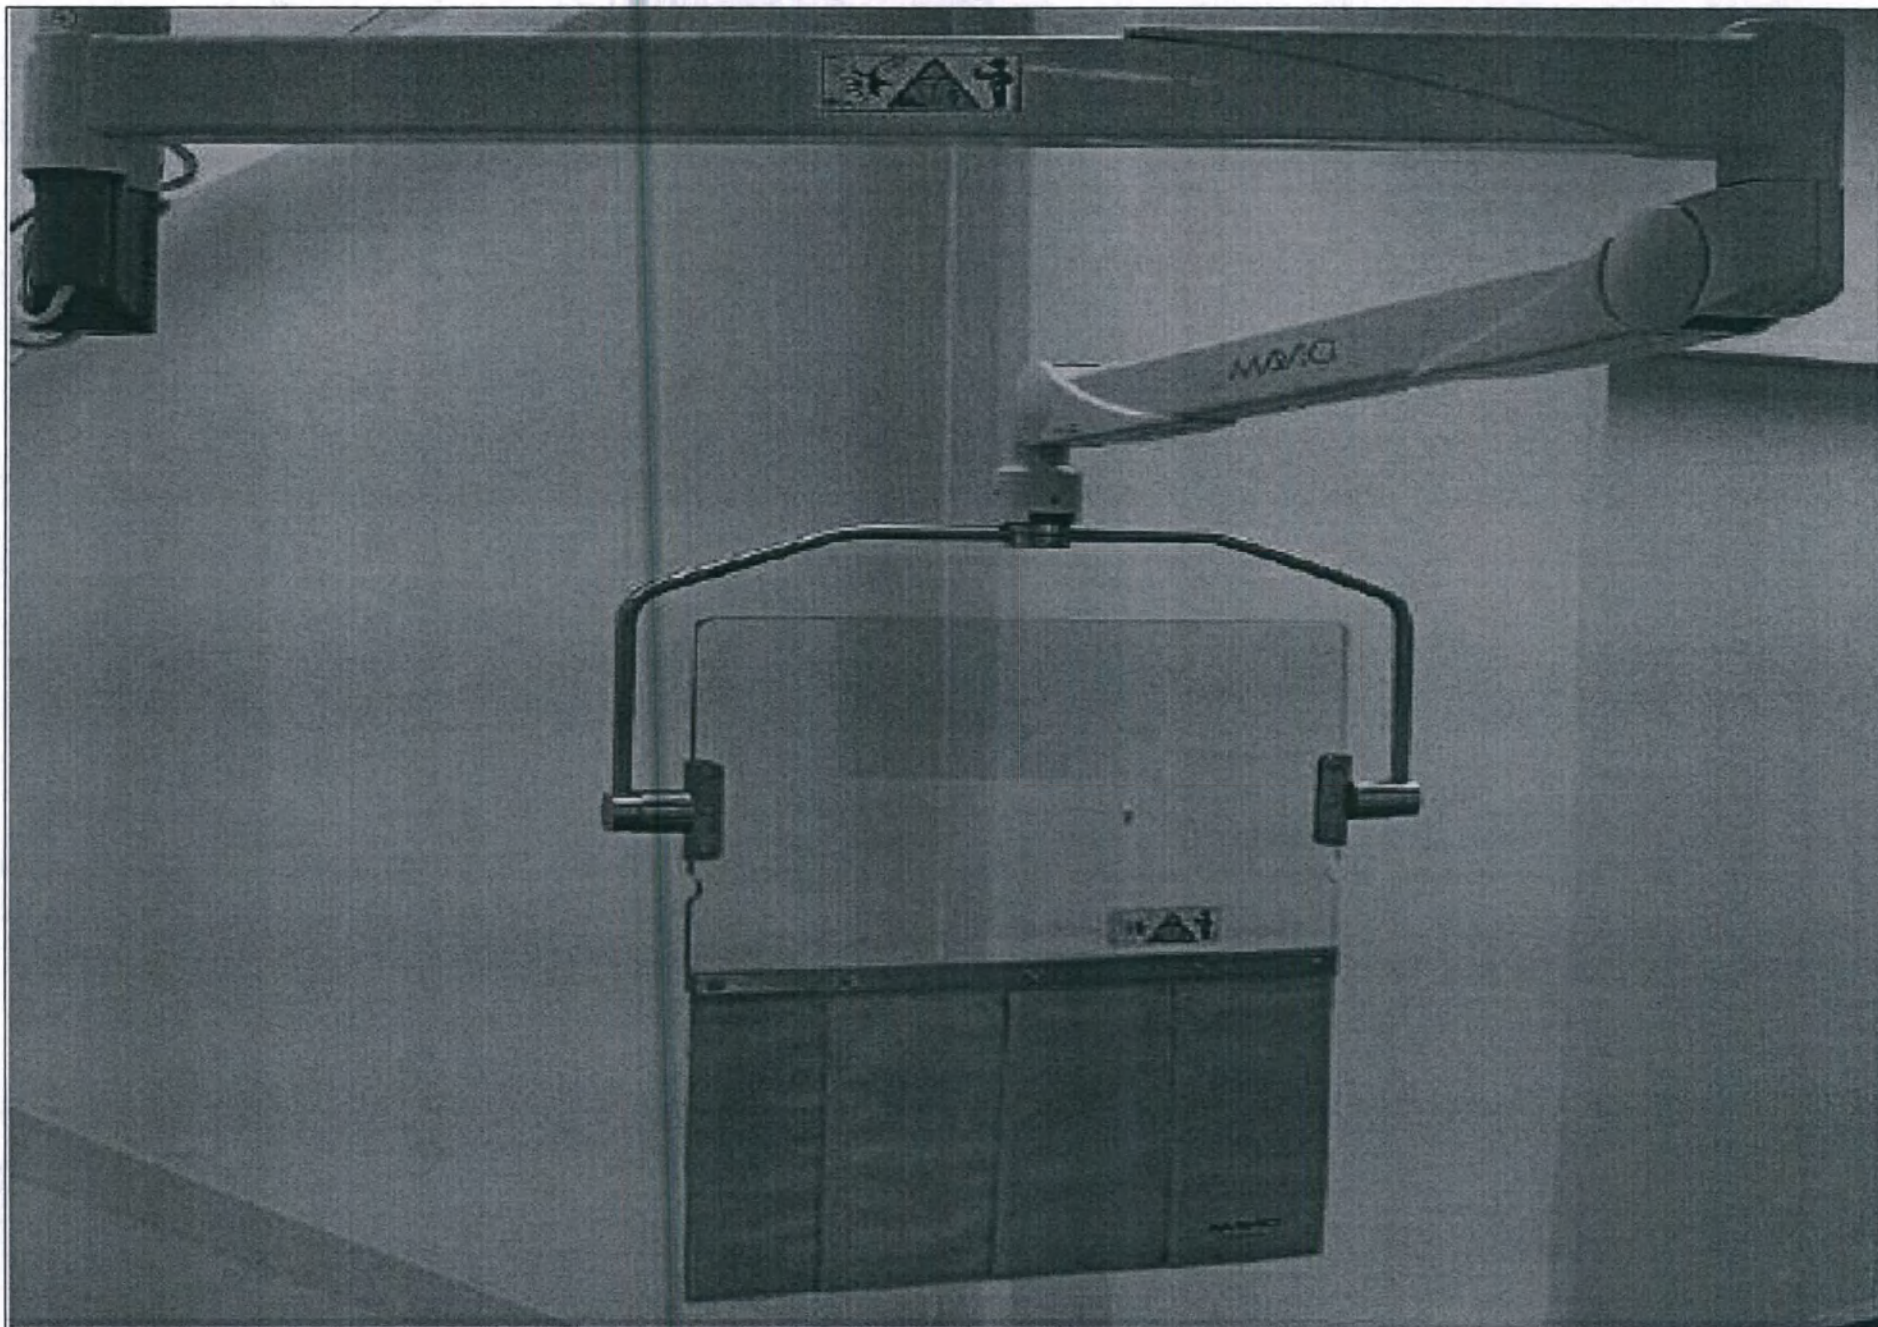

44. Экран радиационной защиты потолочный

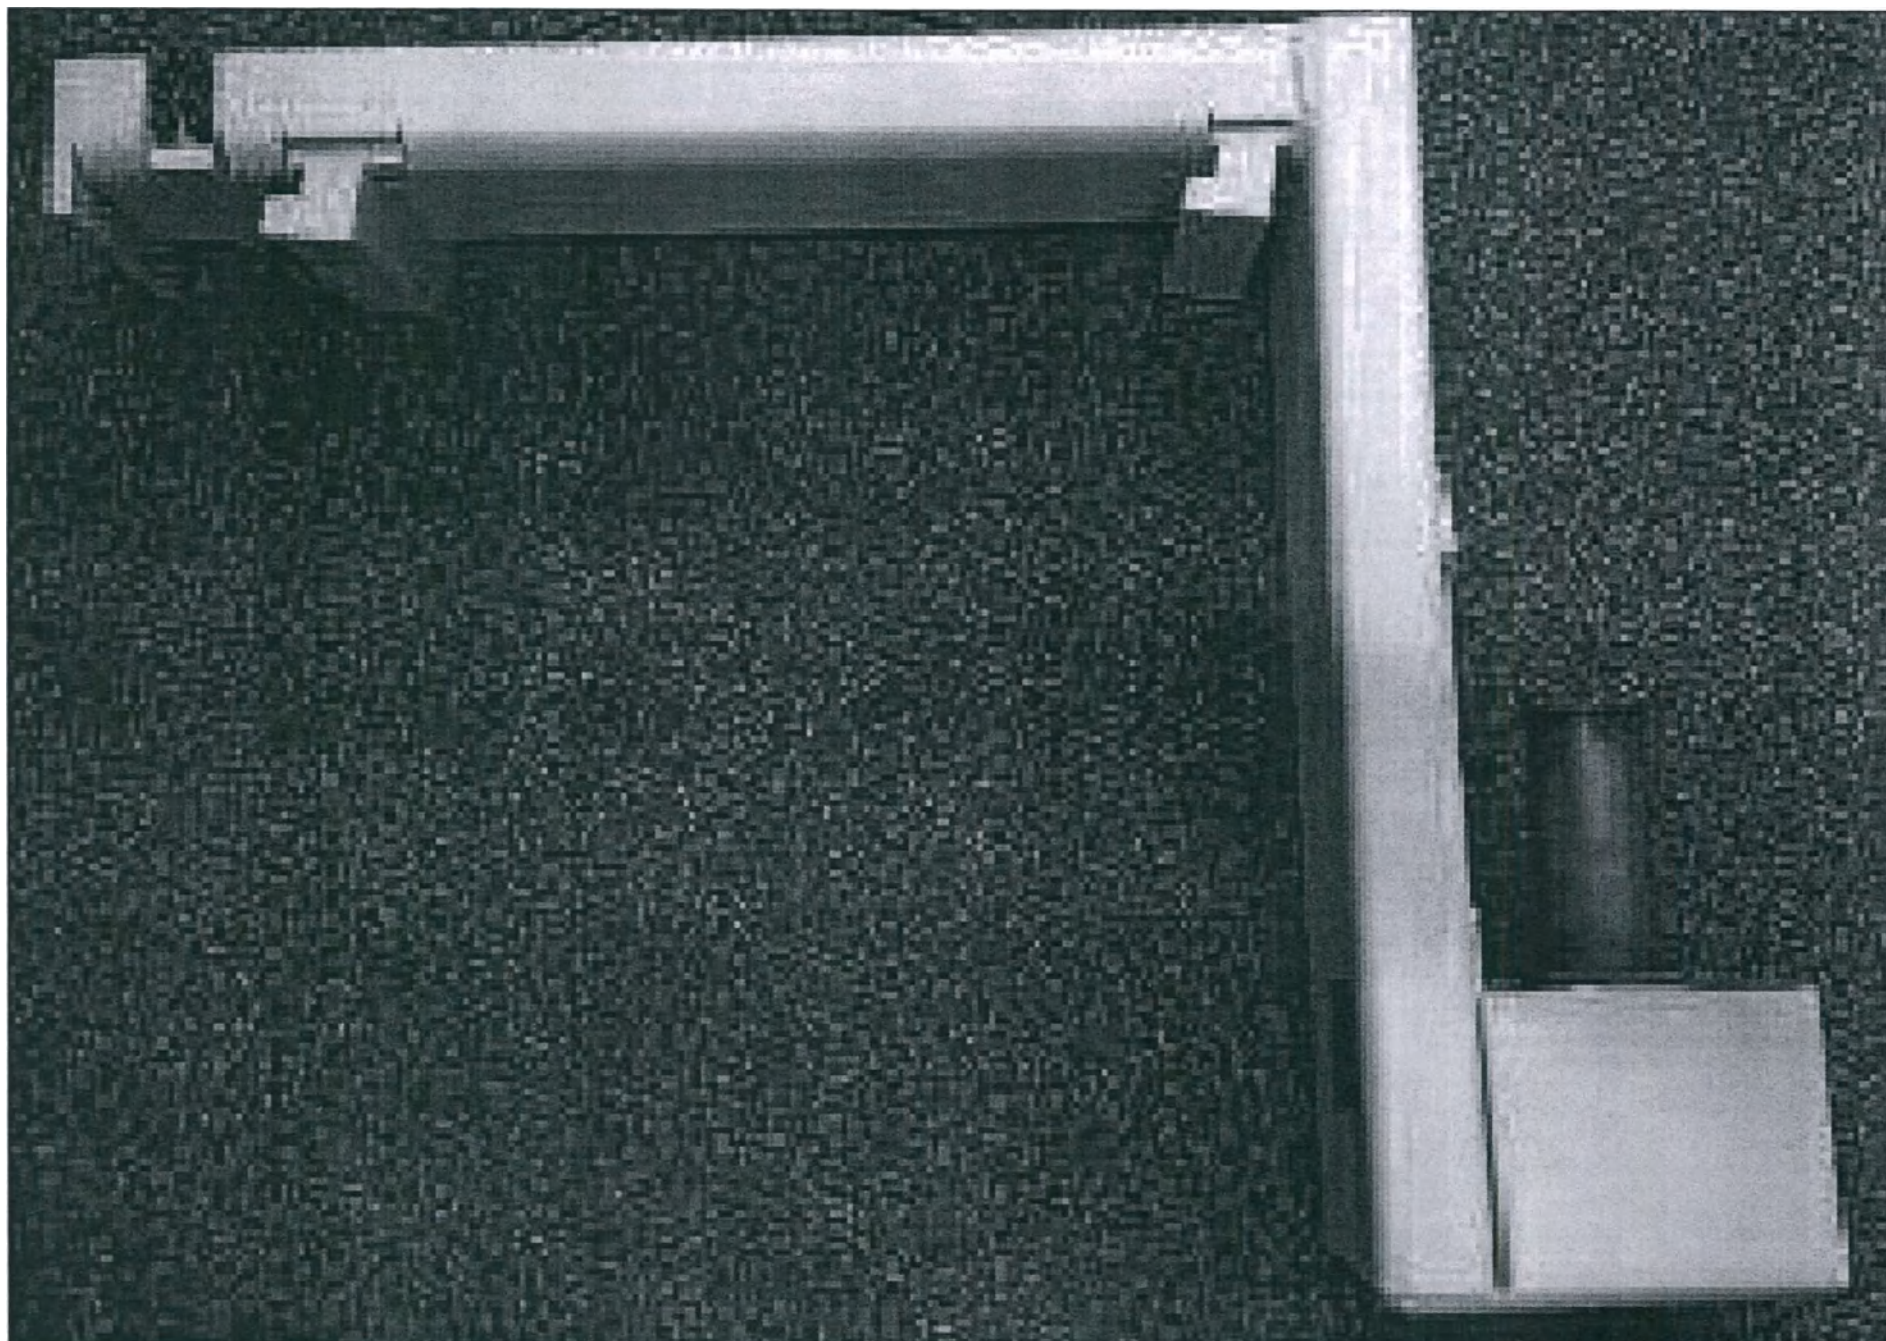


45. Монтажное крепление для экрана радиационной защиты потолочного.

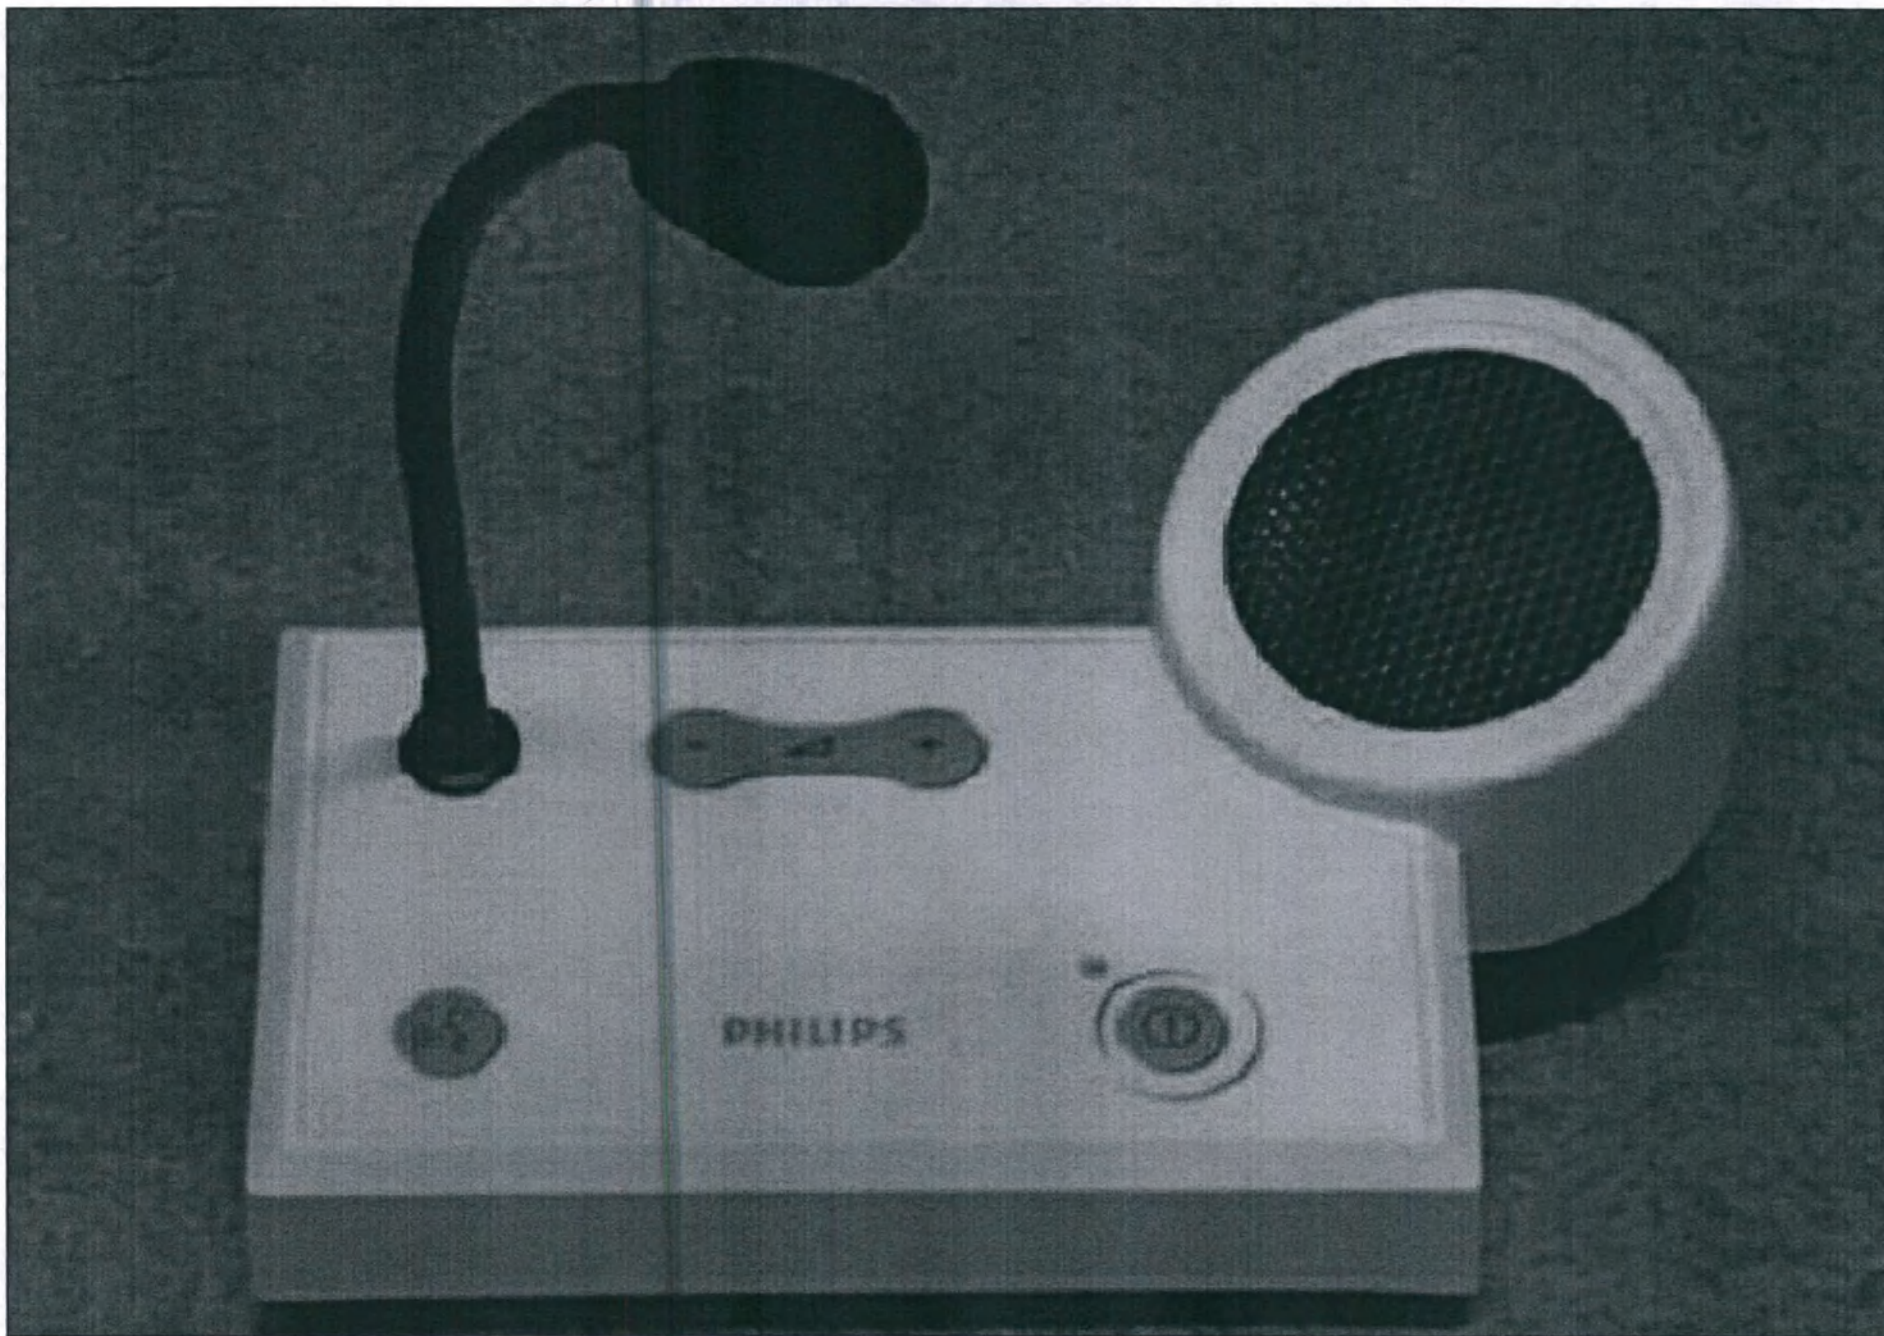


46. Модуль двусторонней связи.




47. Устройство записи DVD для медицинского применения.

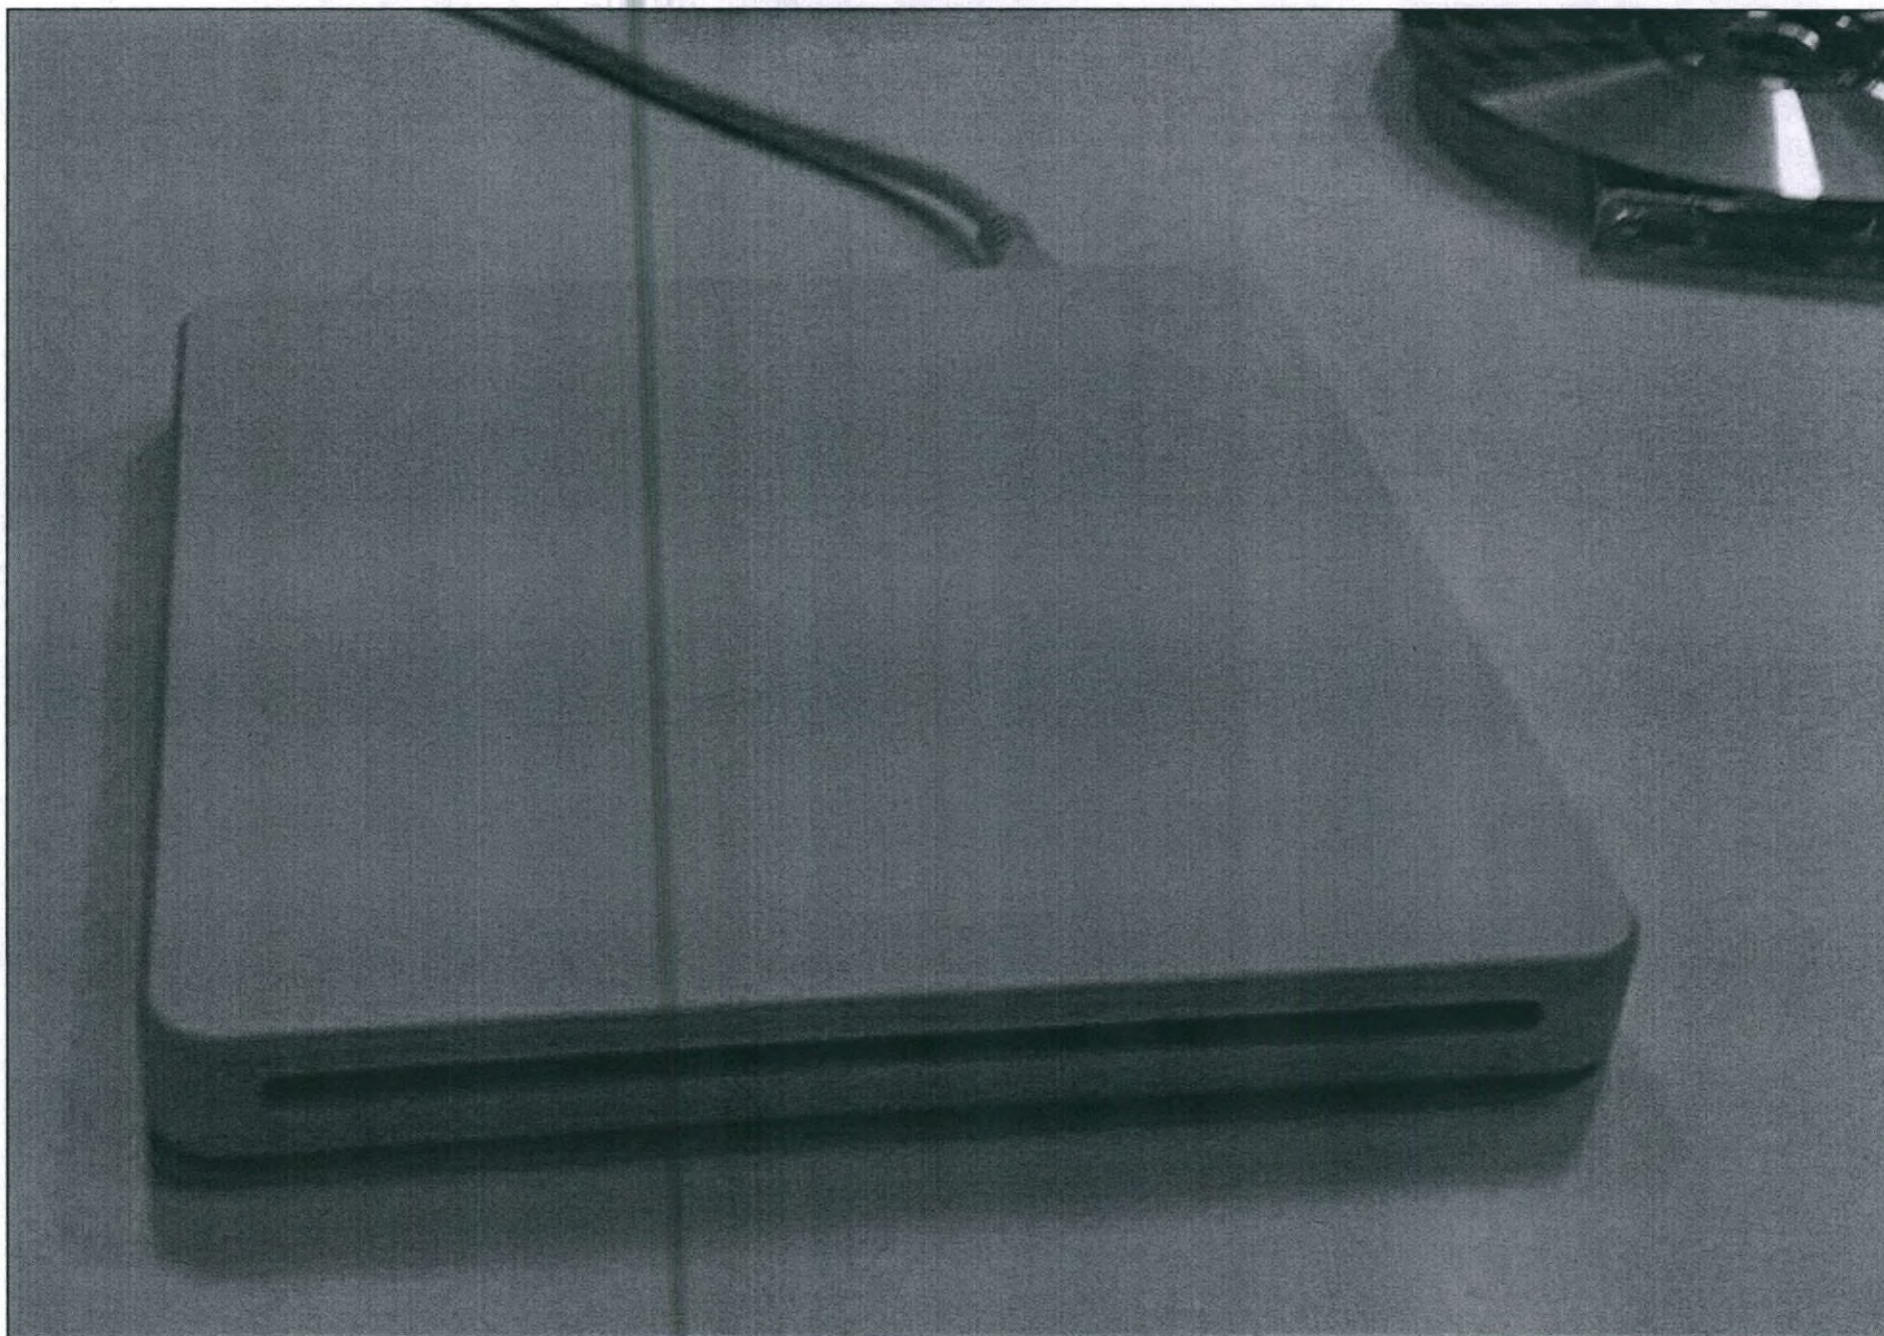

48. Устройство записи *DVD-DICOM* для медицинского применения.

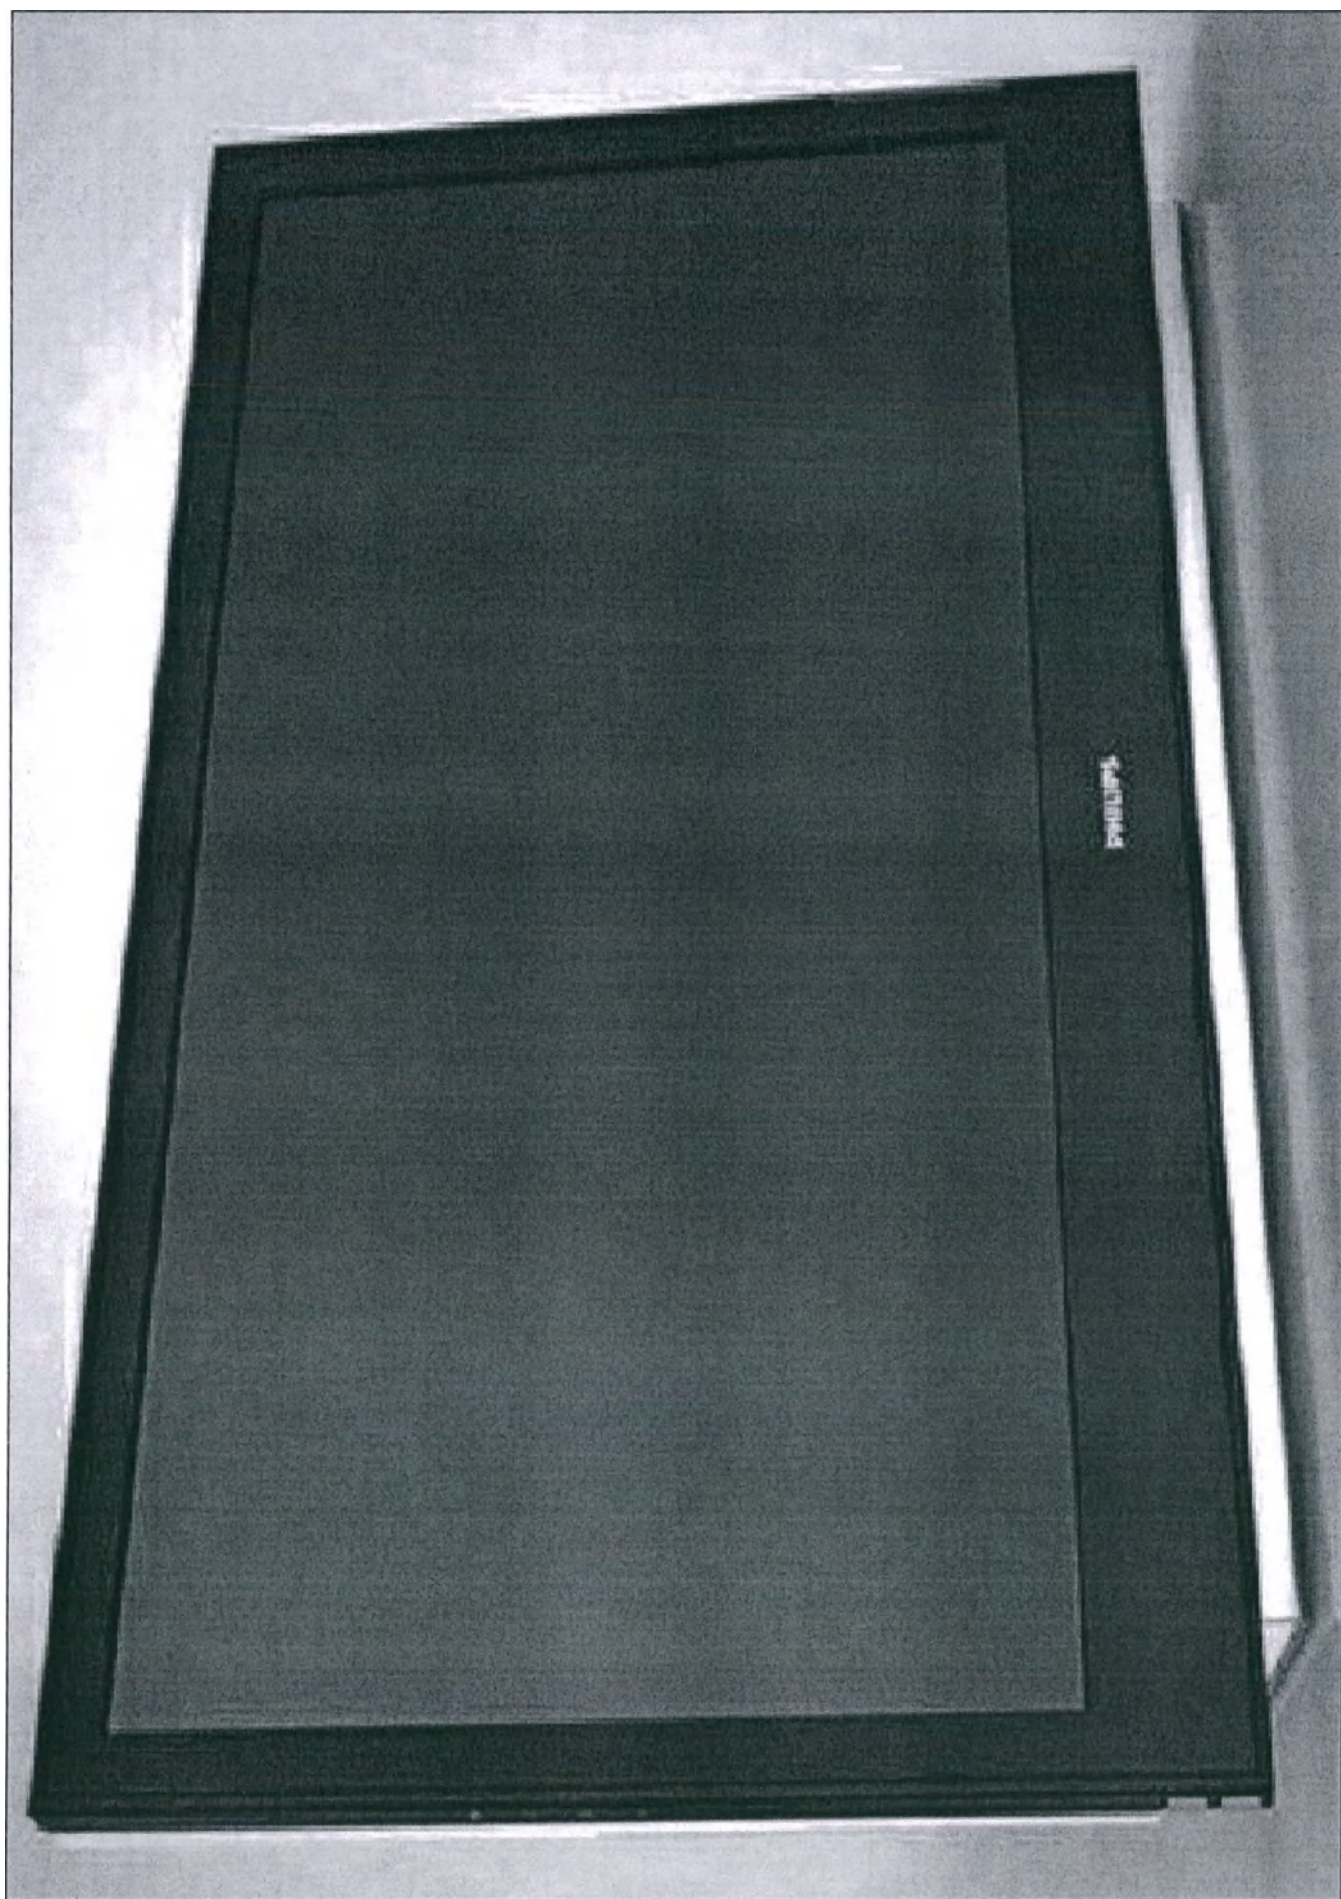


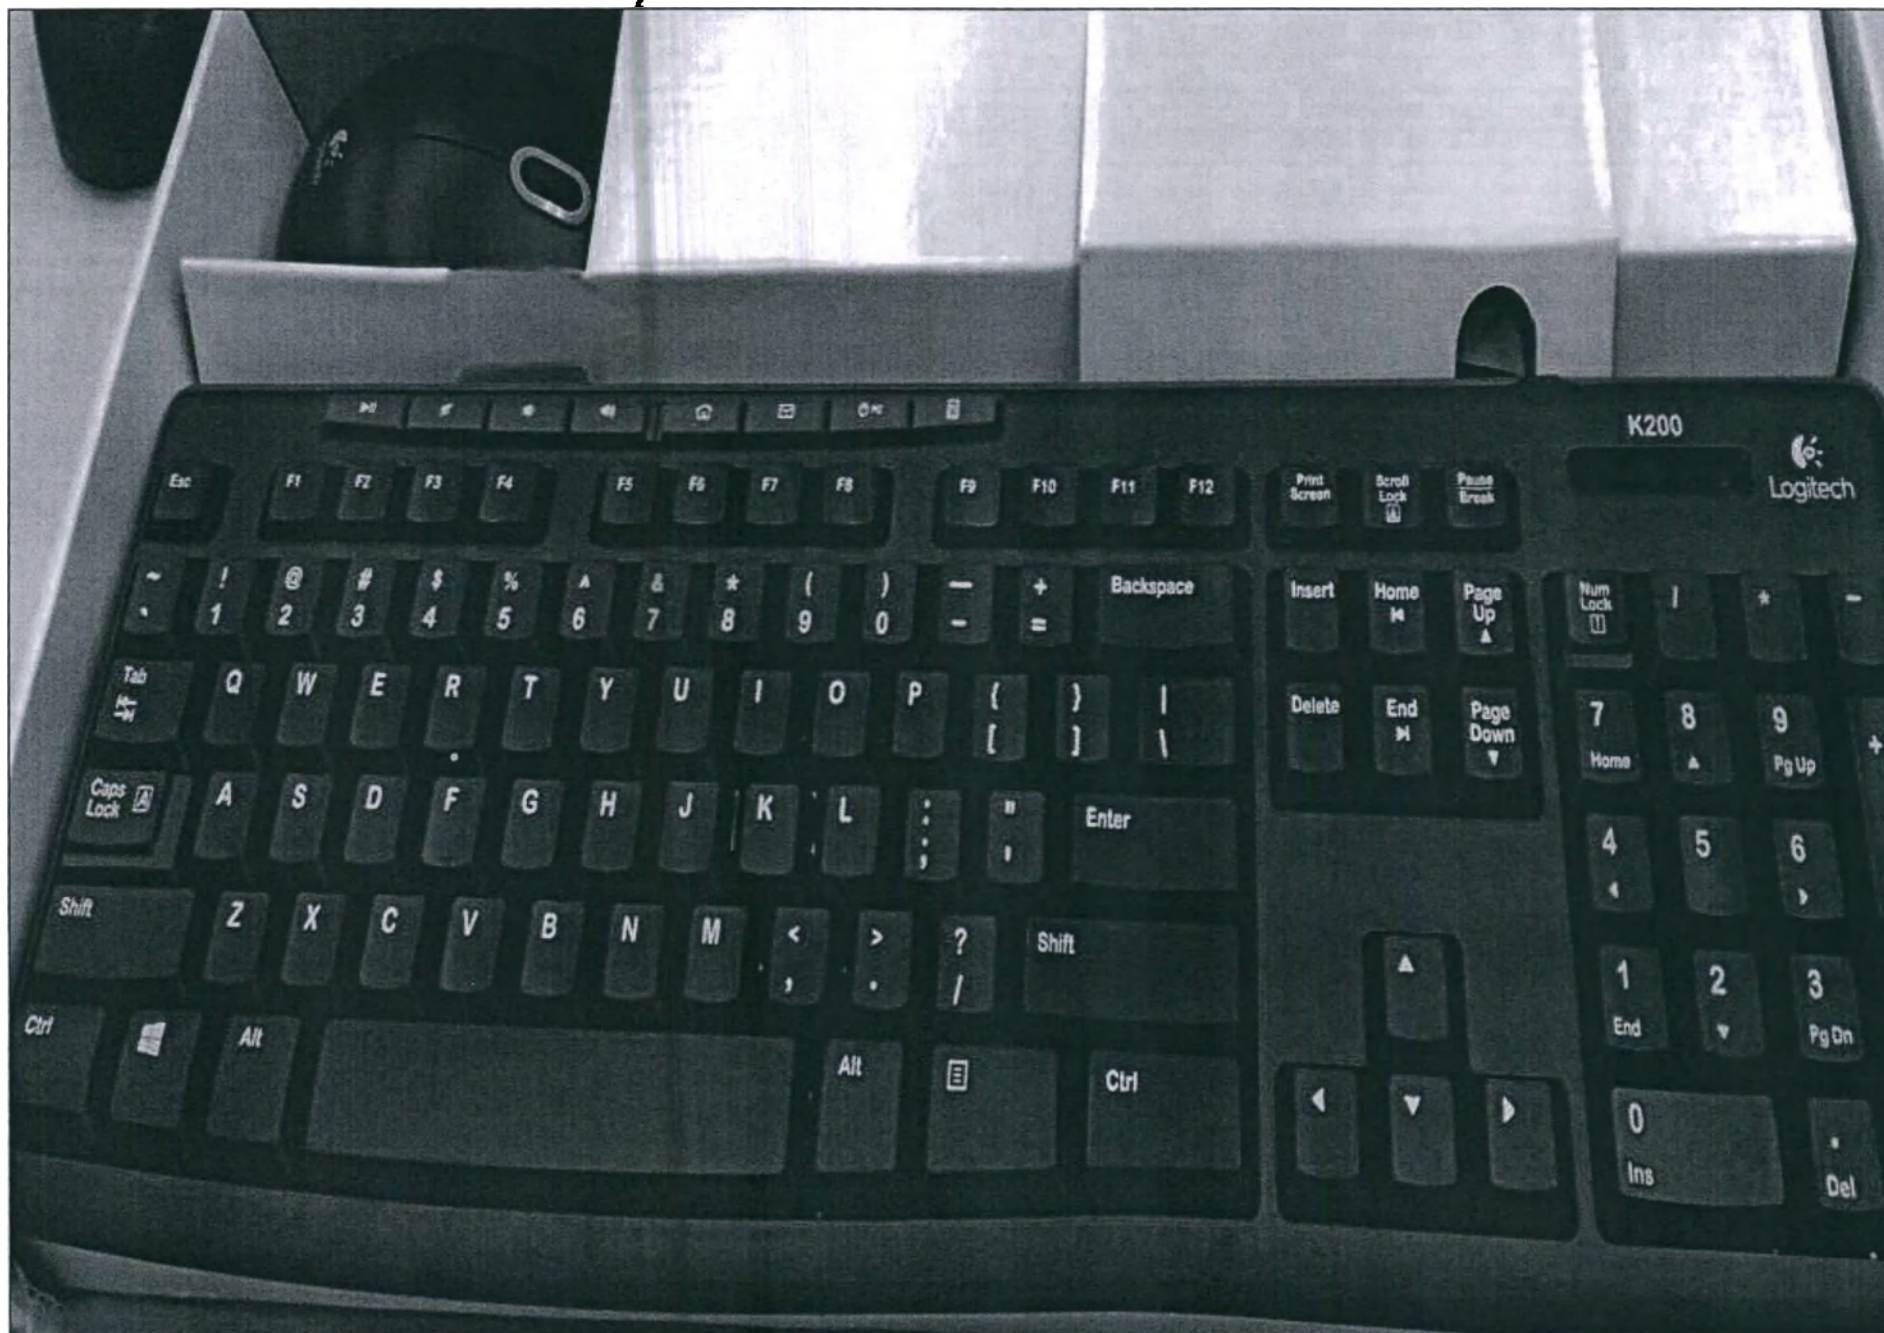

49.в. Рабочая станция для интервенционных инструментов: цветной монитор с диагональю 24 дюйма, клавиатура, мышь, блок обработки данных пациента.



49.г. Рабочая станция для интервенционных инструментов: цветной монитор с диагональю 24 дюйма, клавиатура, **мышь**, блок обработки данных пациента.

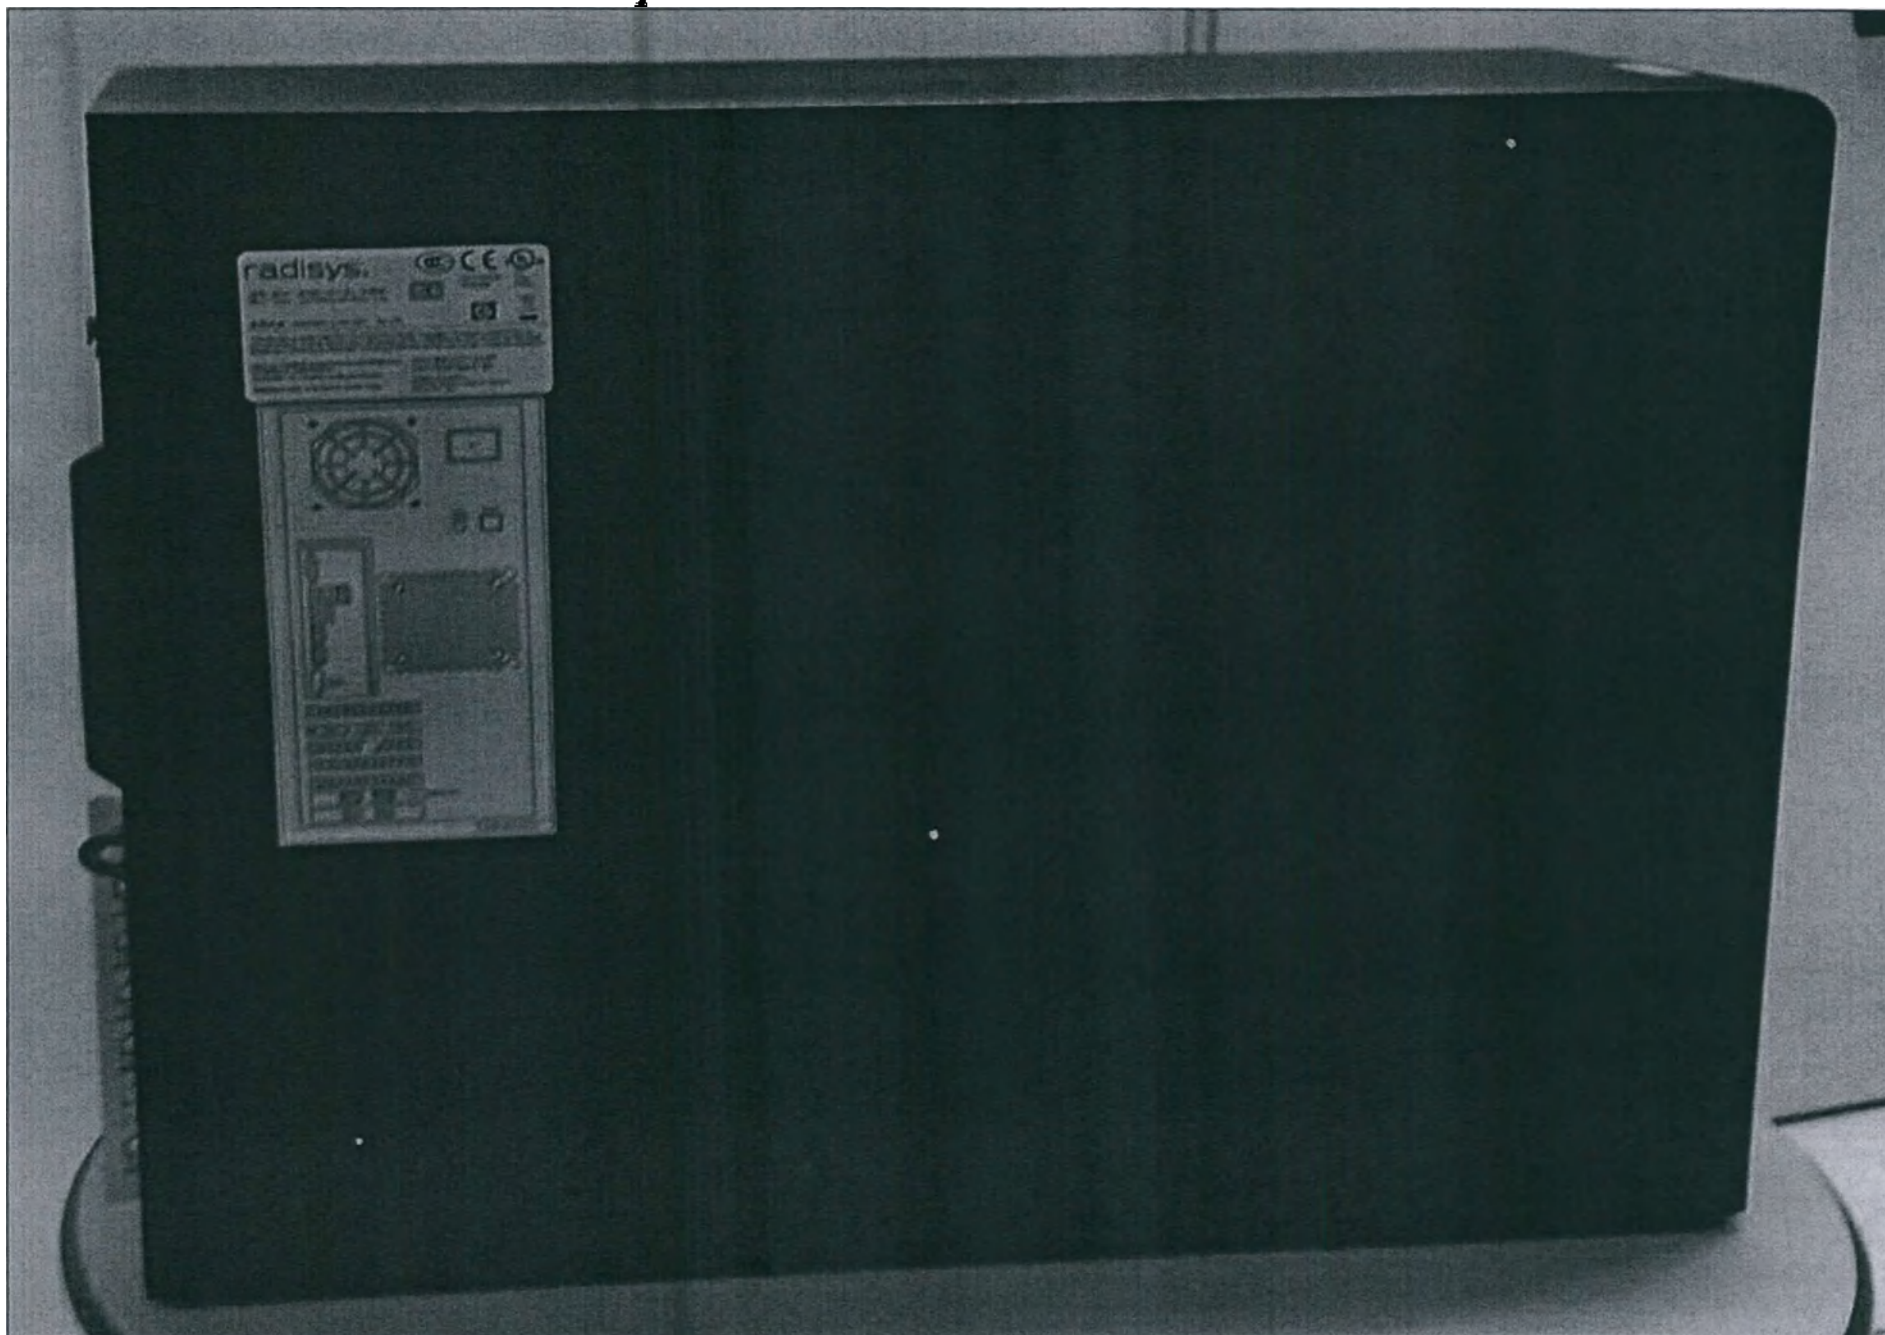


49.д. Рабочая станция для интервенционных инструментов: цветной монитор с диагональю 24 дюйма, клавиатура, мышь, блок обработки данных пациента.




49.e. Рабочая станция для интервенционных инструментов: цветной монитор с диагональю 24 дюйма, клавиатура, мышь, блок обработки данных пациента.




50. а. Модули программные

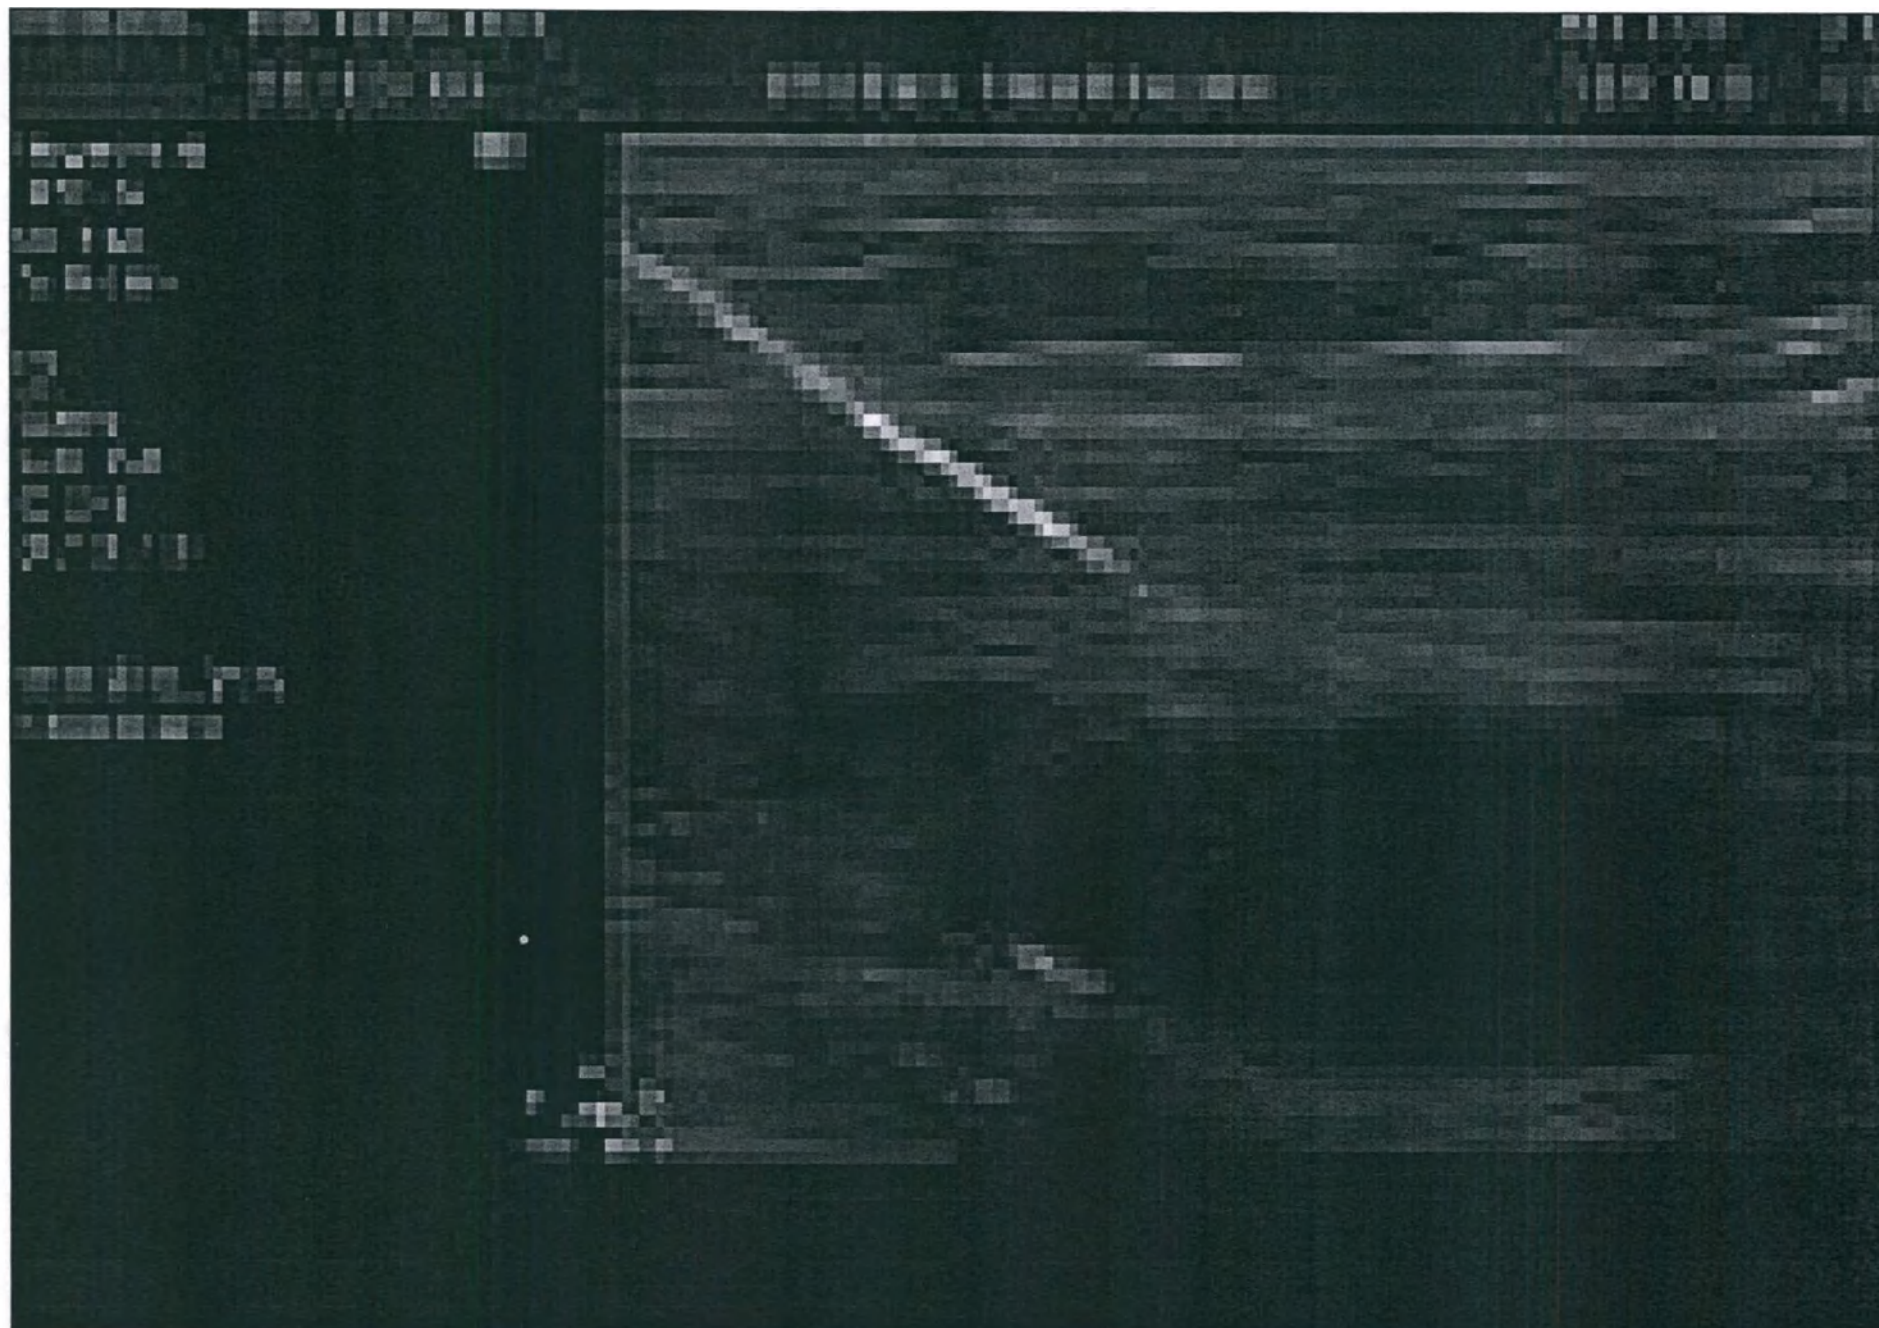


50.6. Модули программные

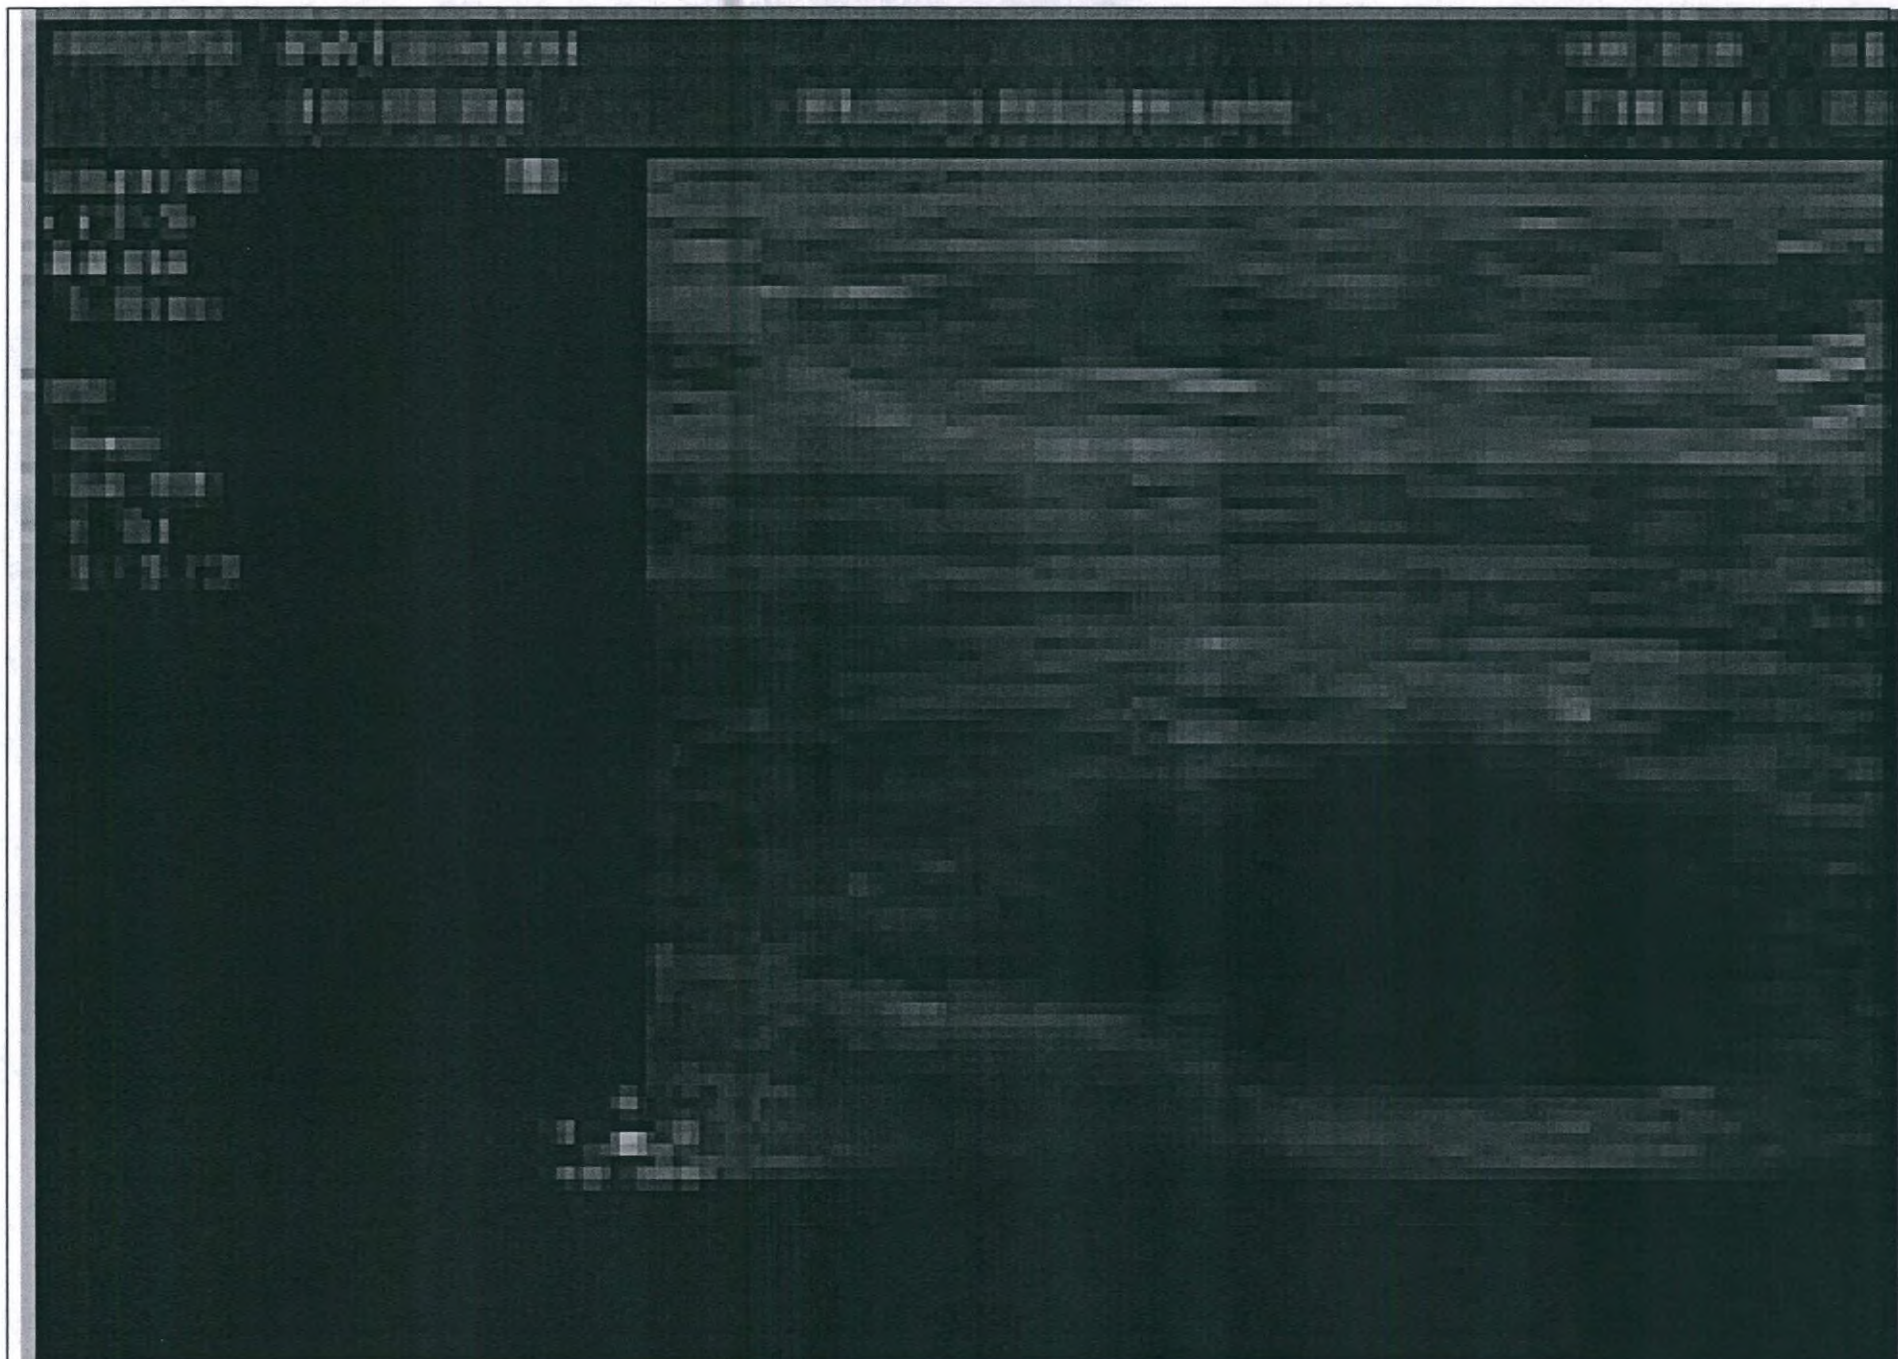


50.в. Модули программные

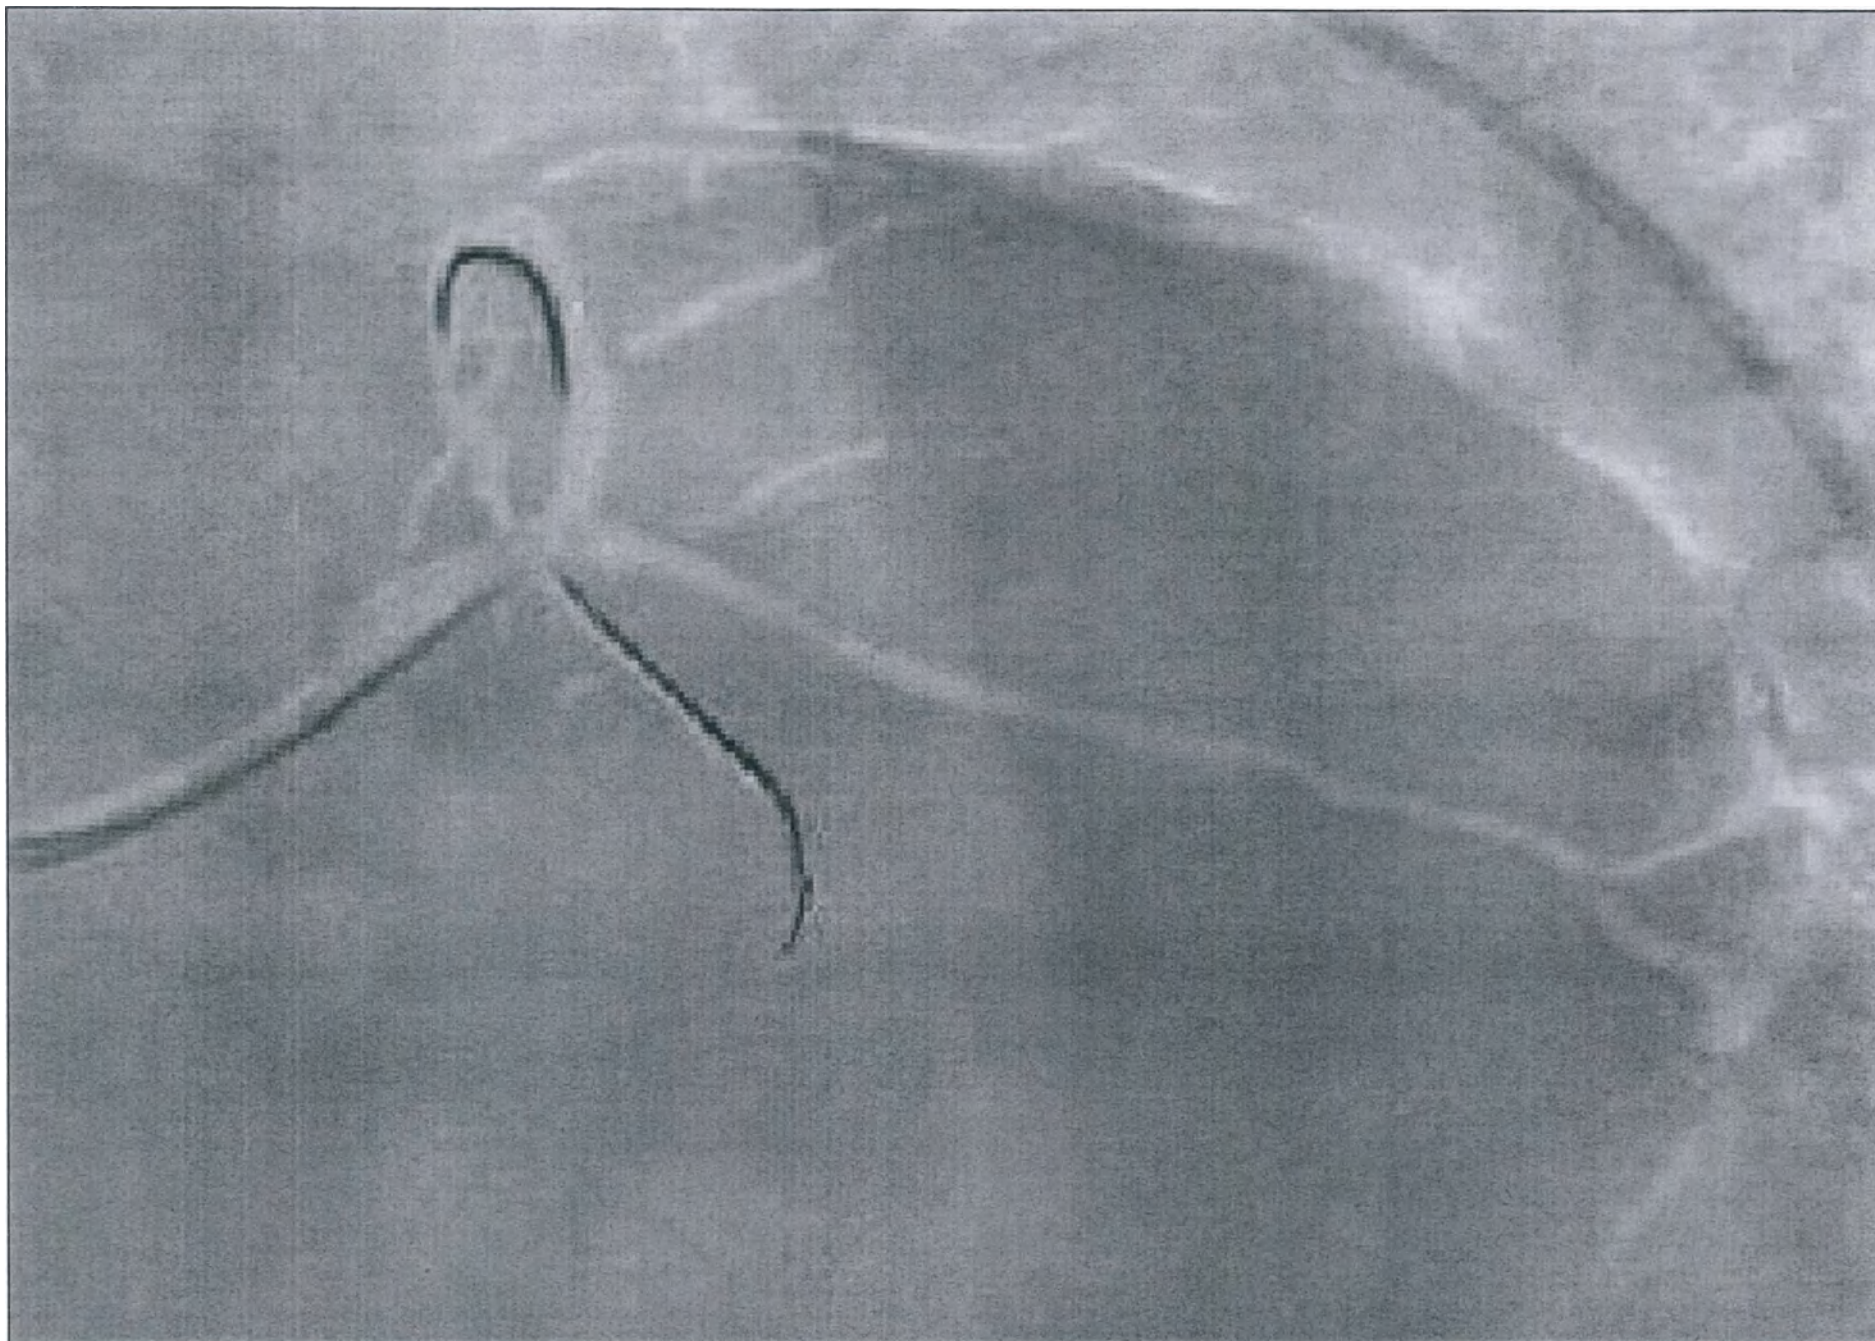


50.г. Модули программные

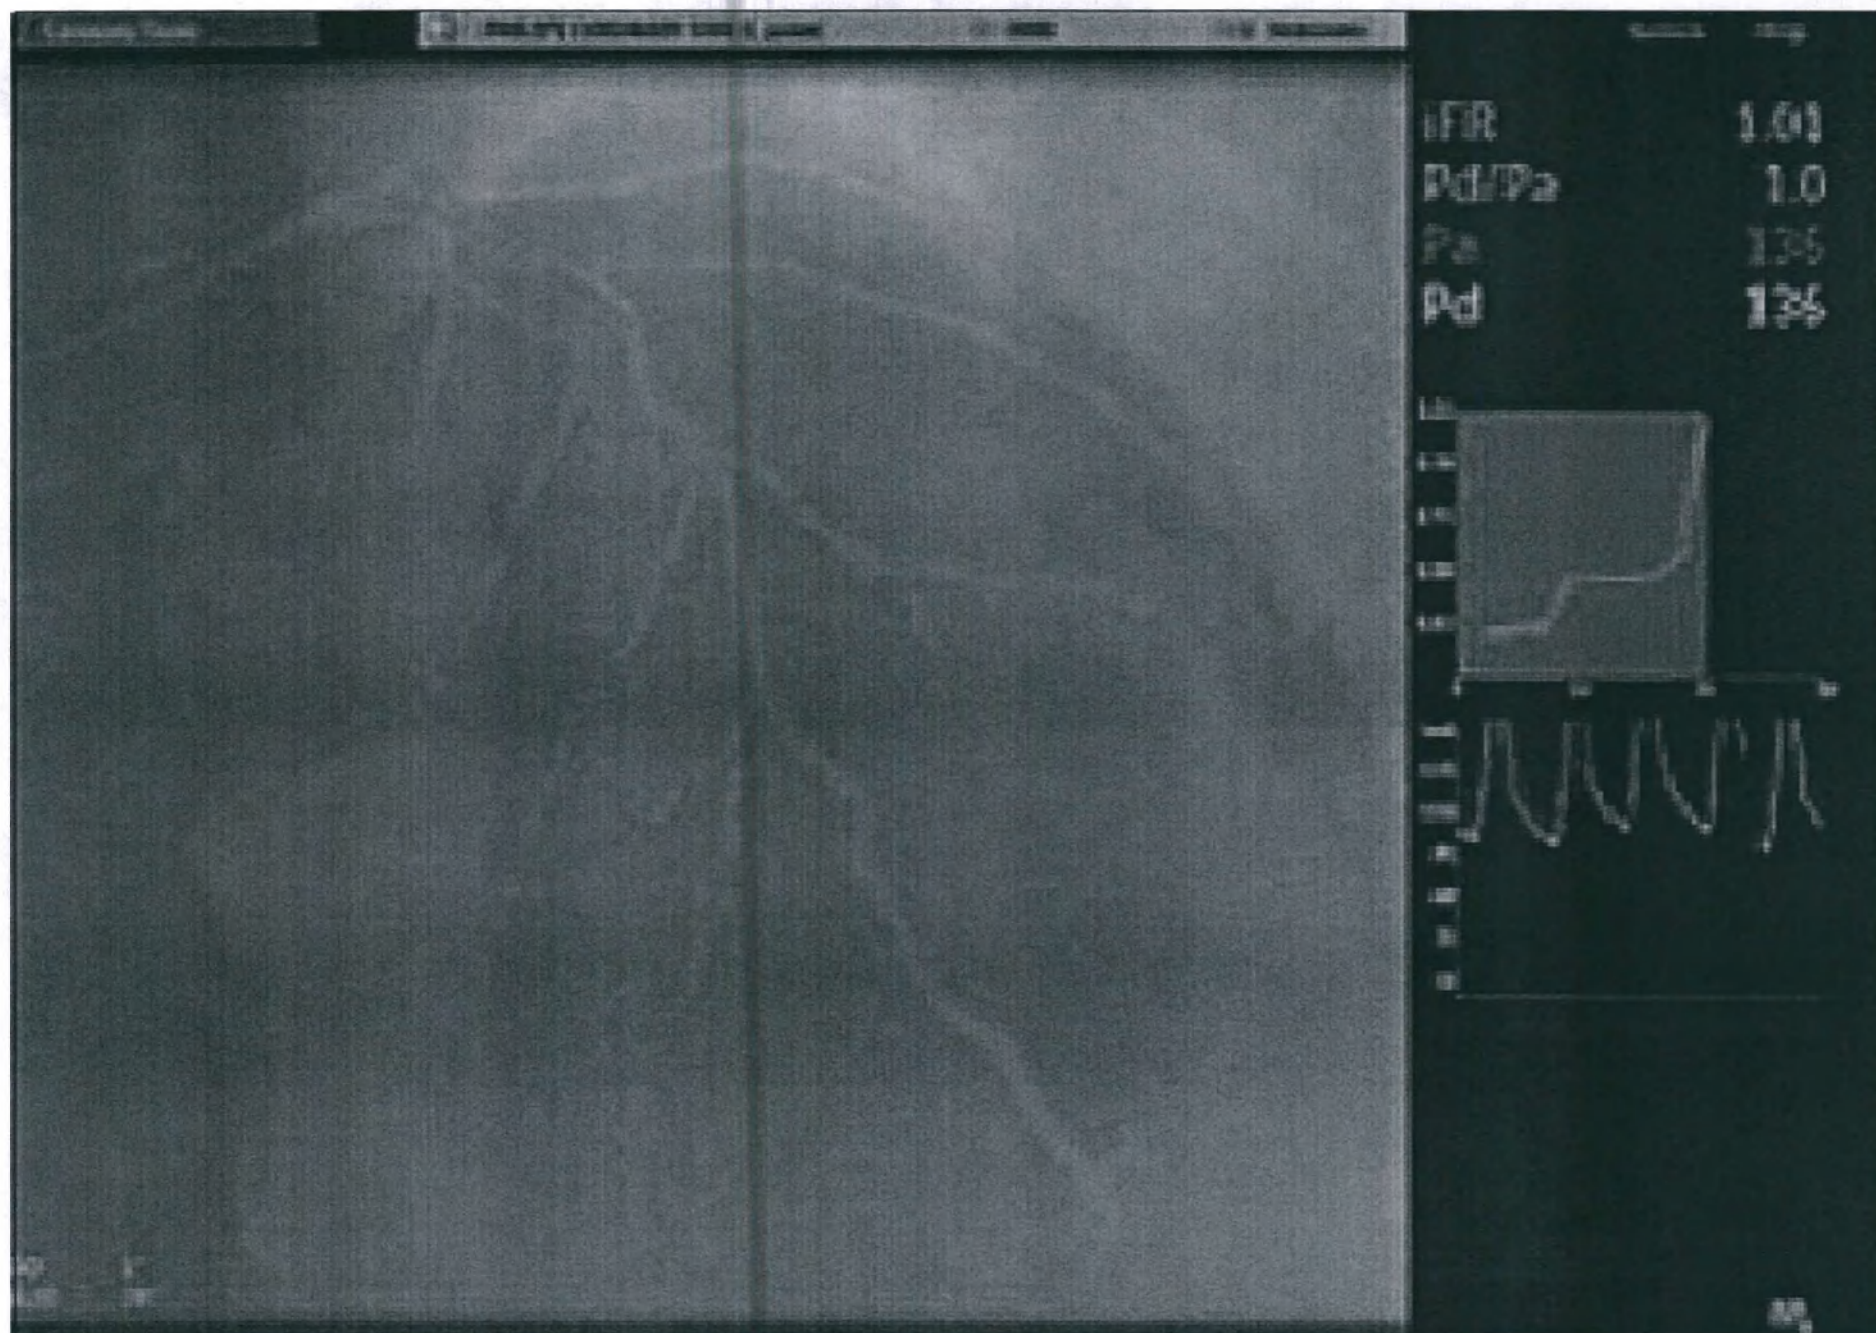


50.д. Модули программные

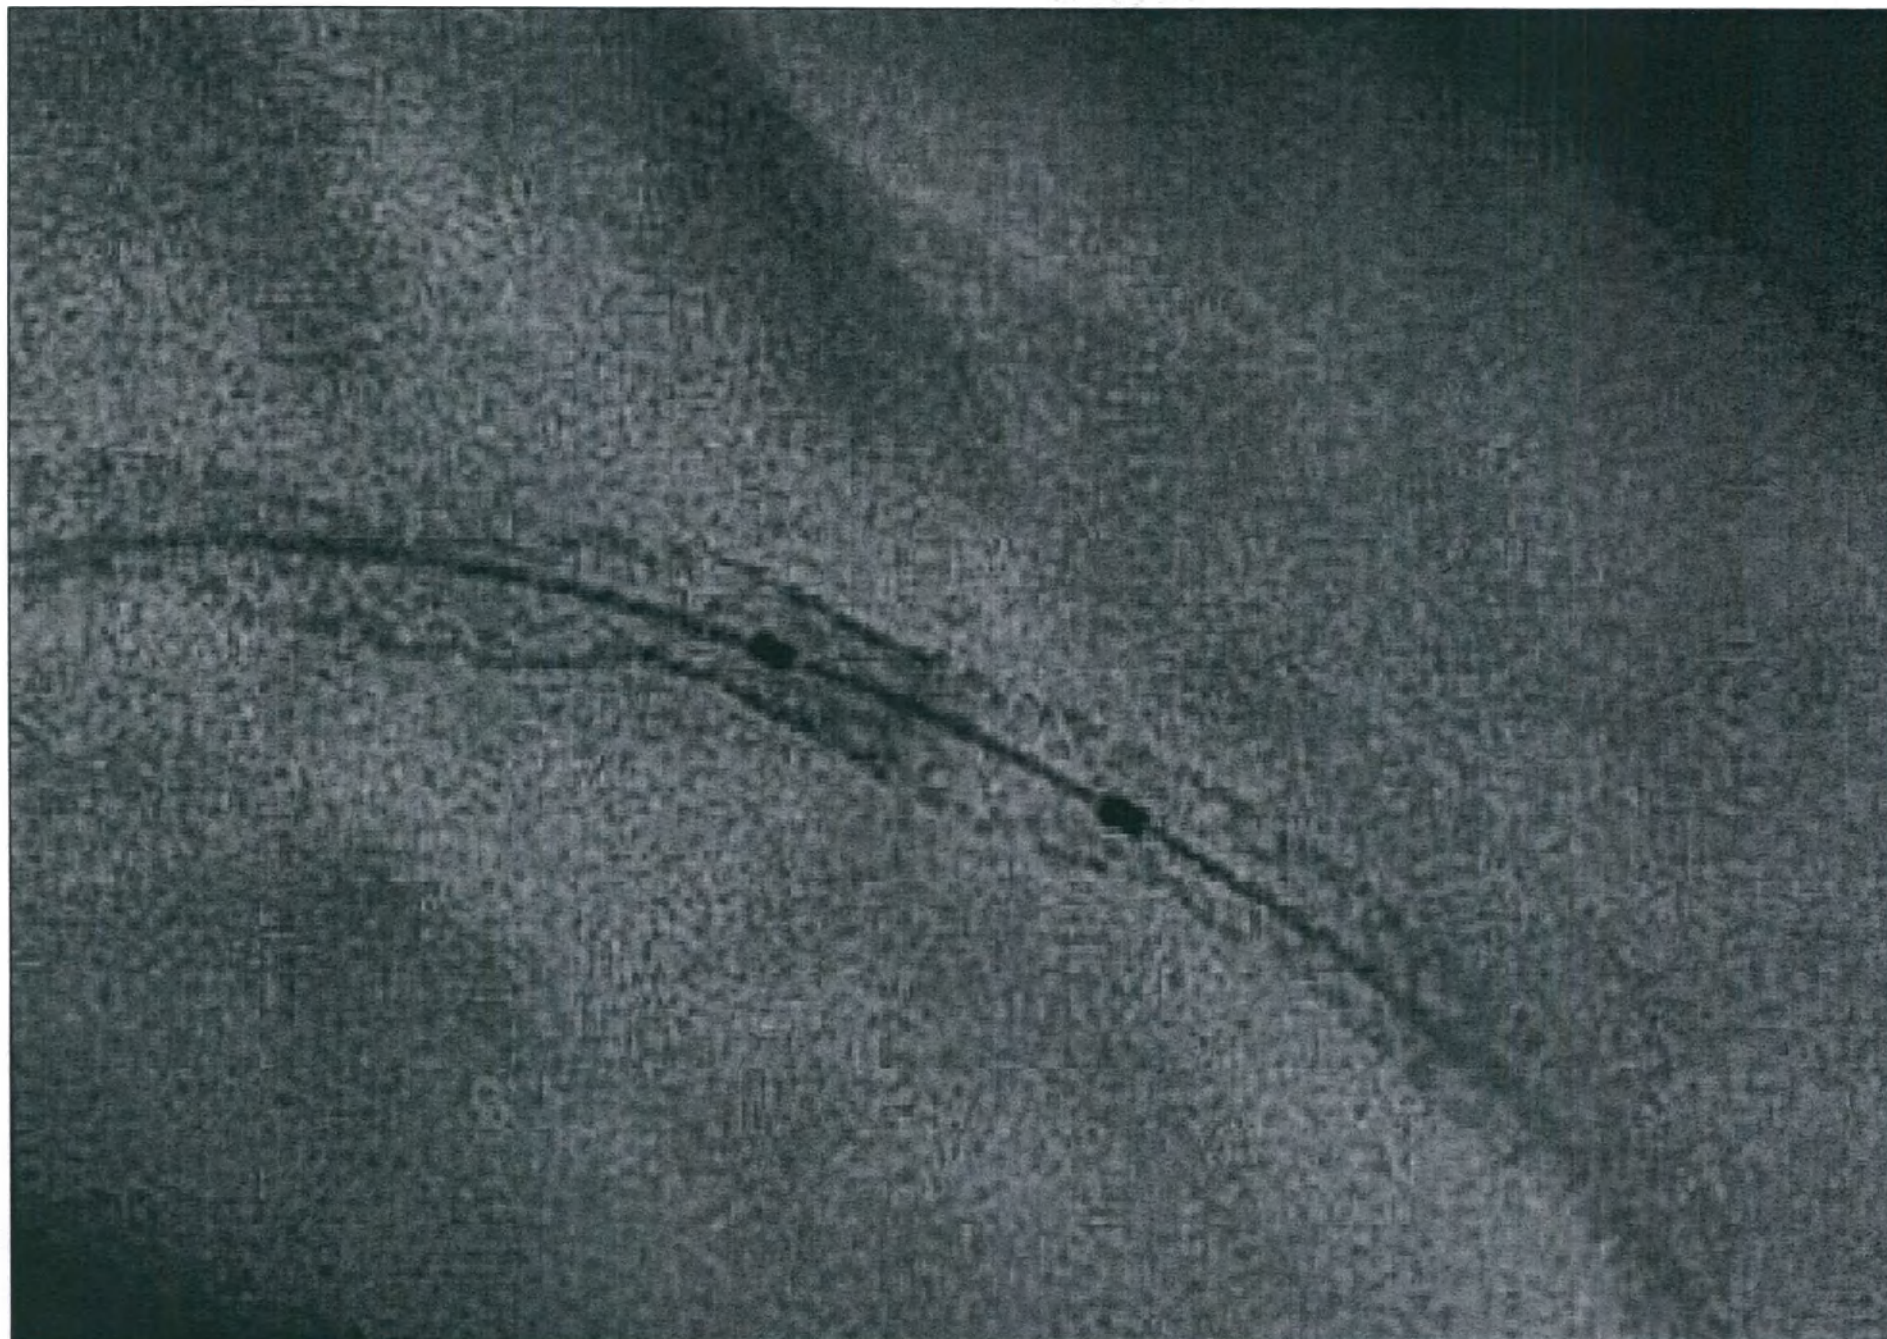


50.e. Модули программные

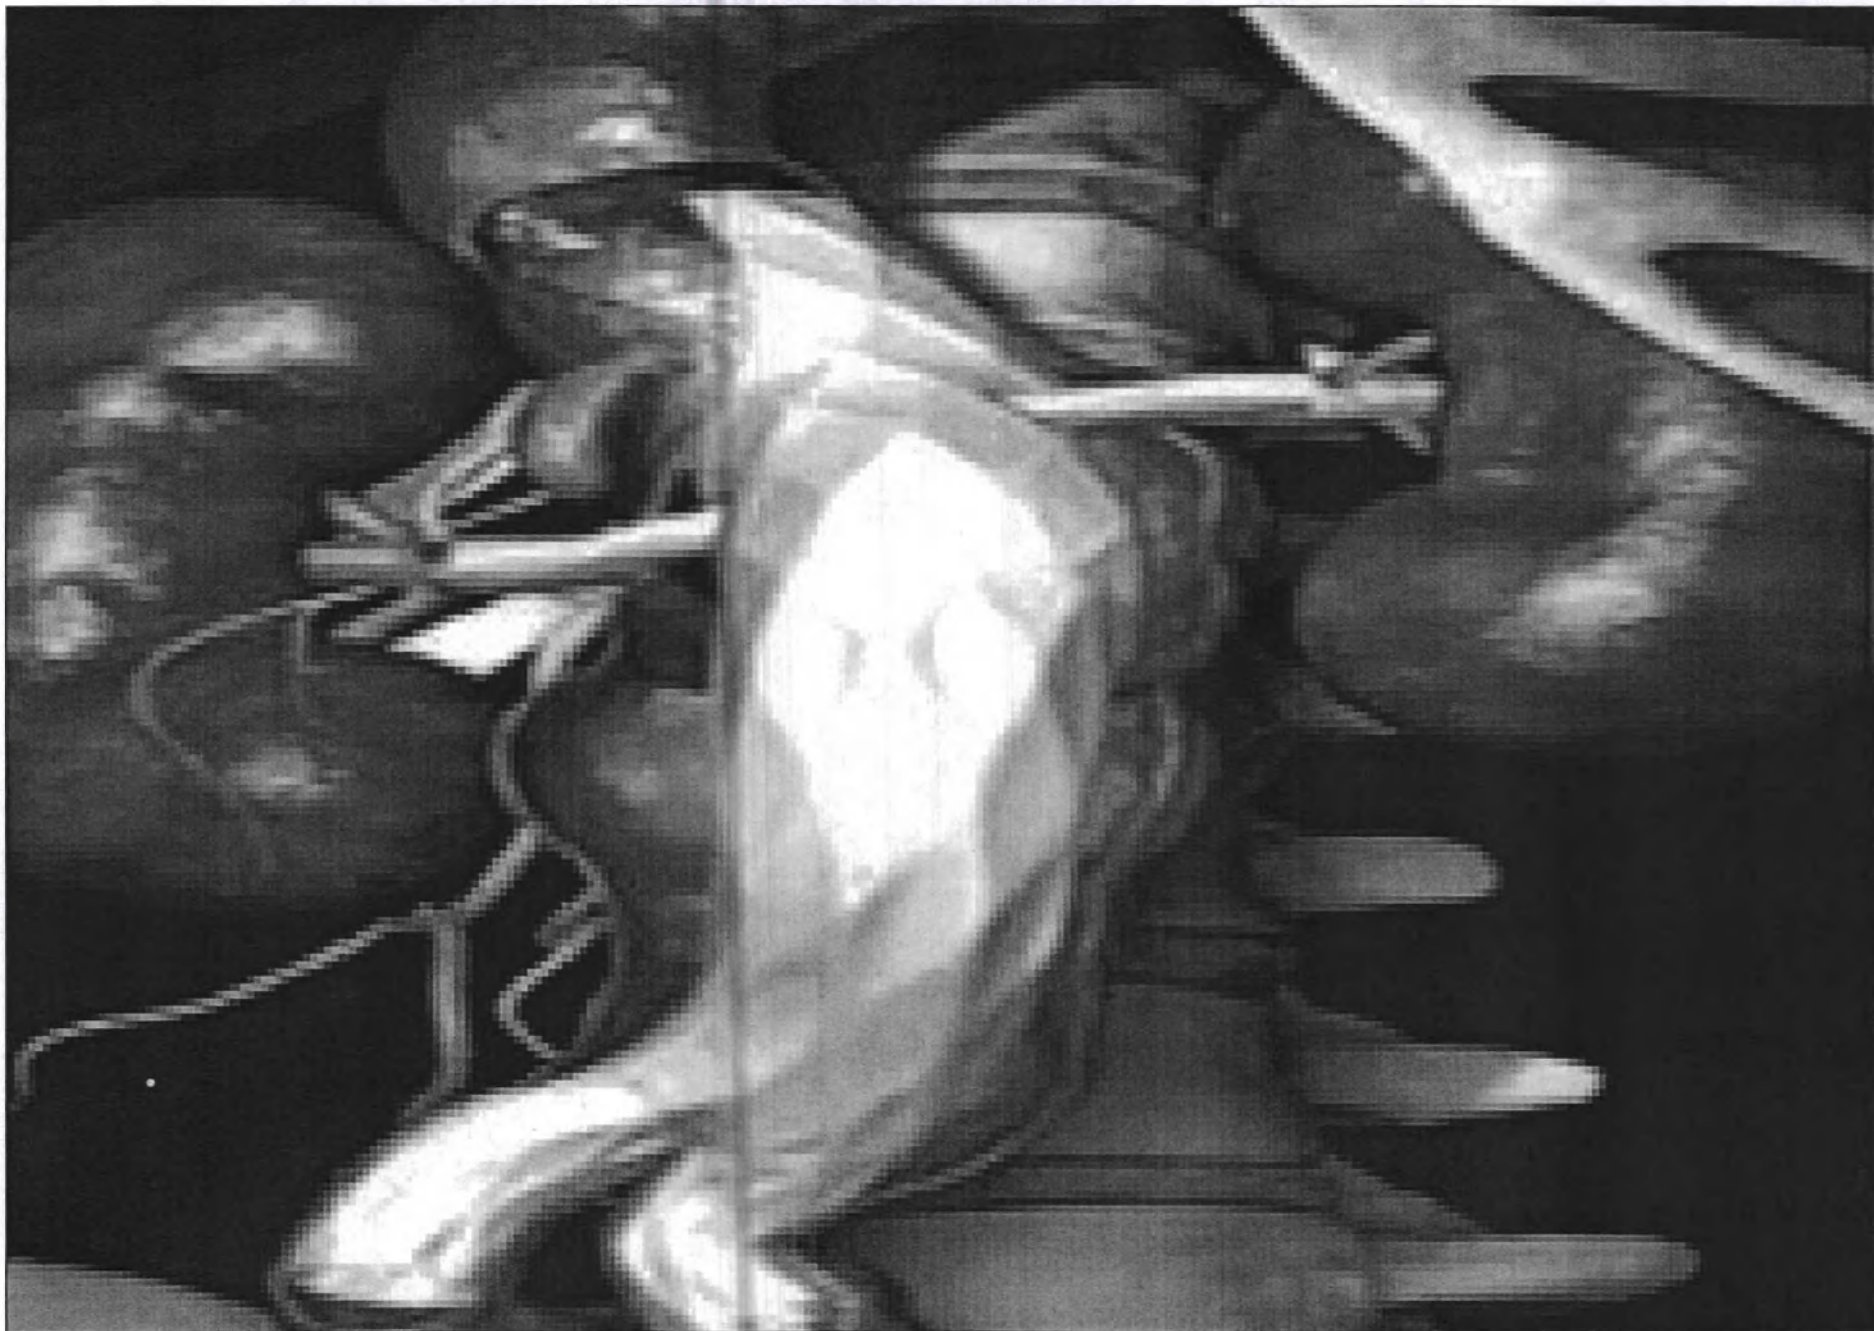


50.ж. Модули программные

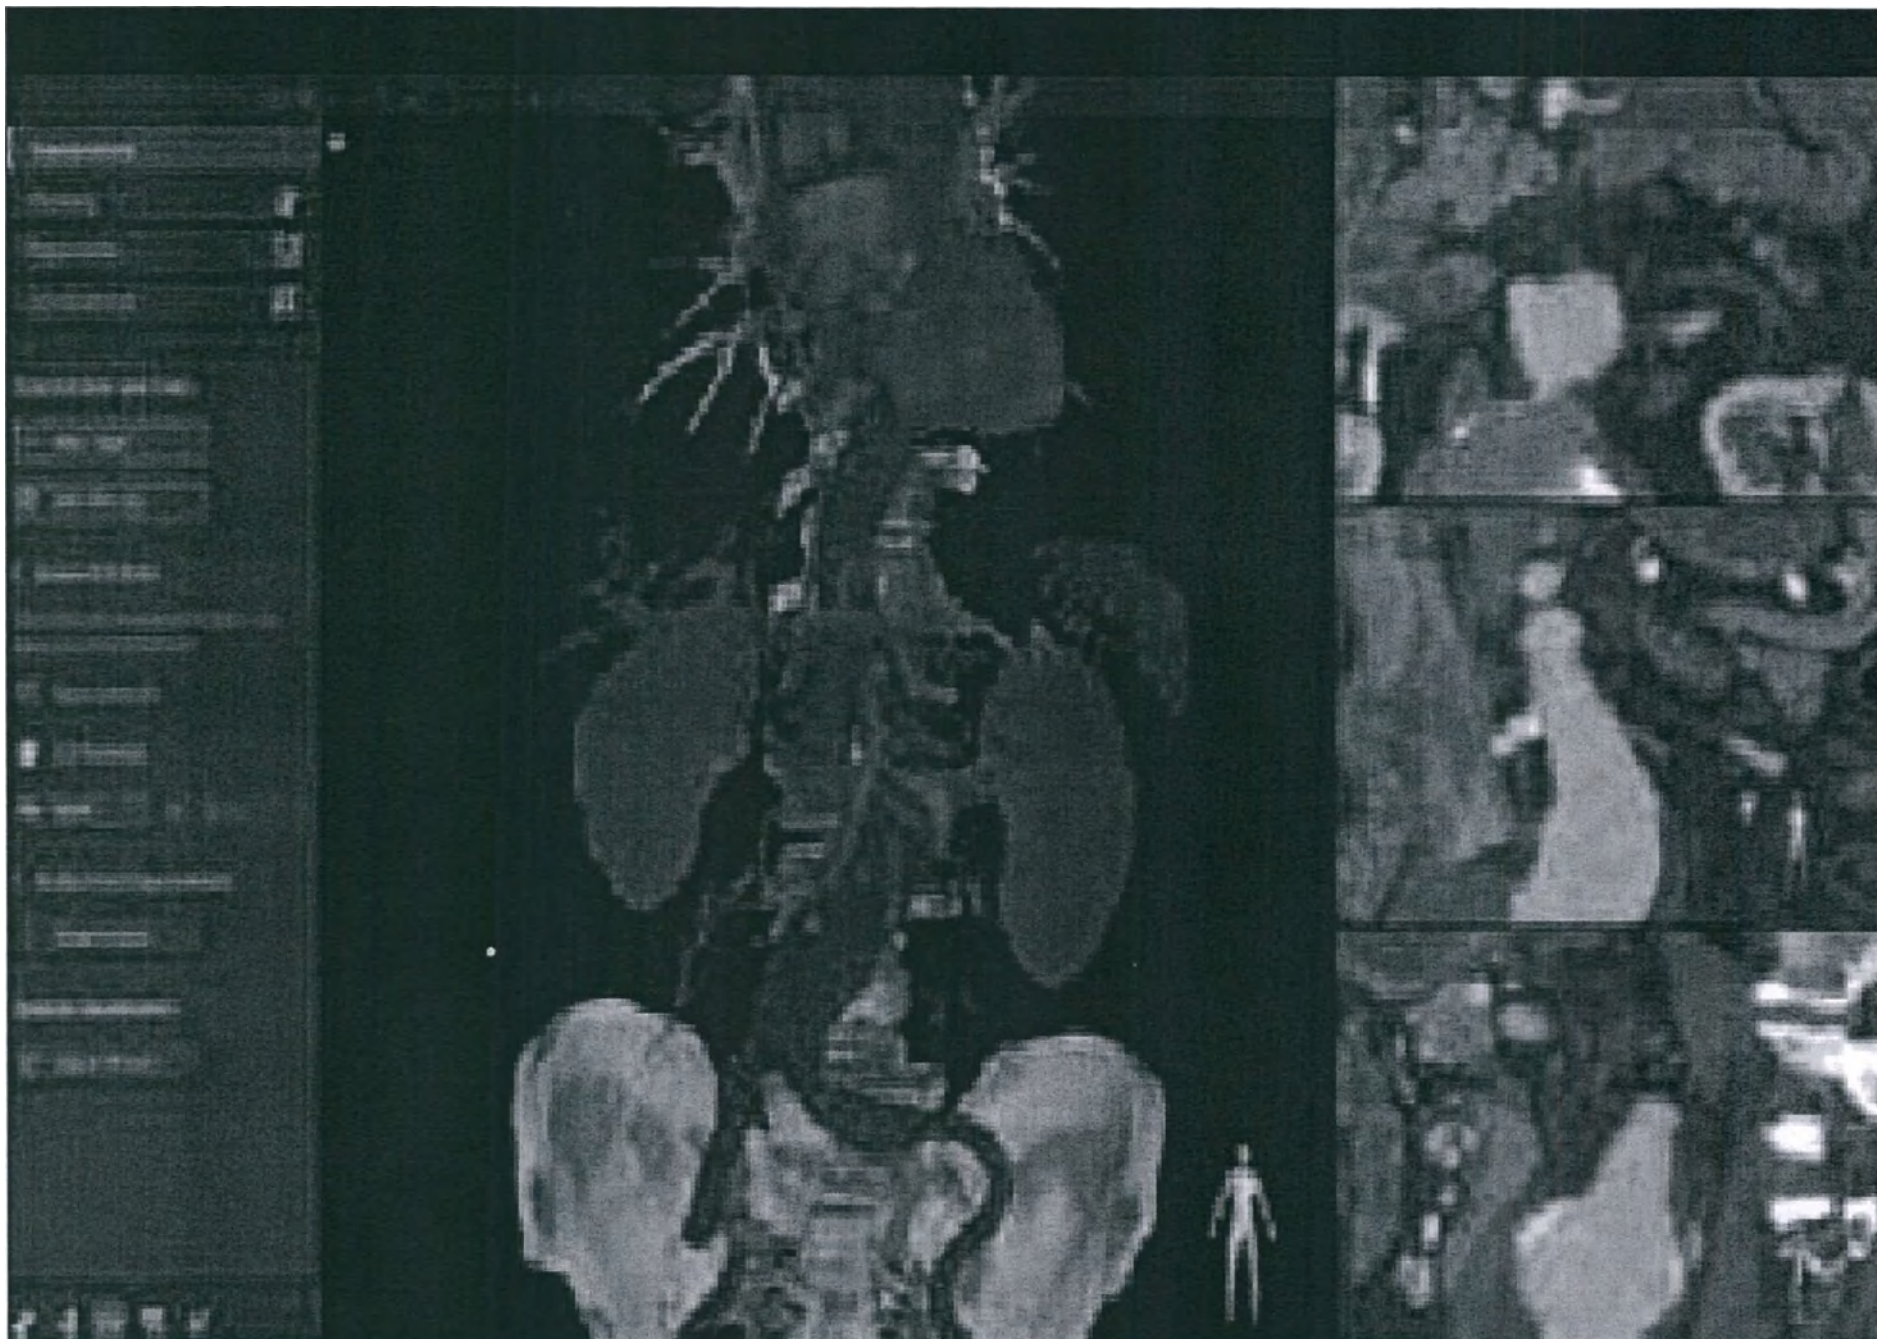



50.3. Модули программные

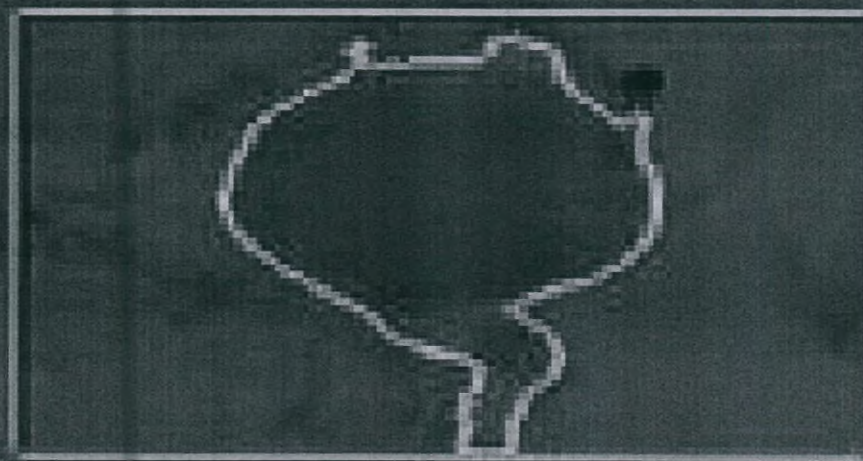


50.и. Модули программные

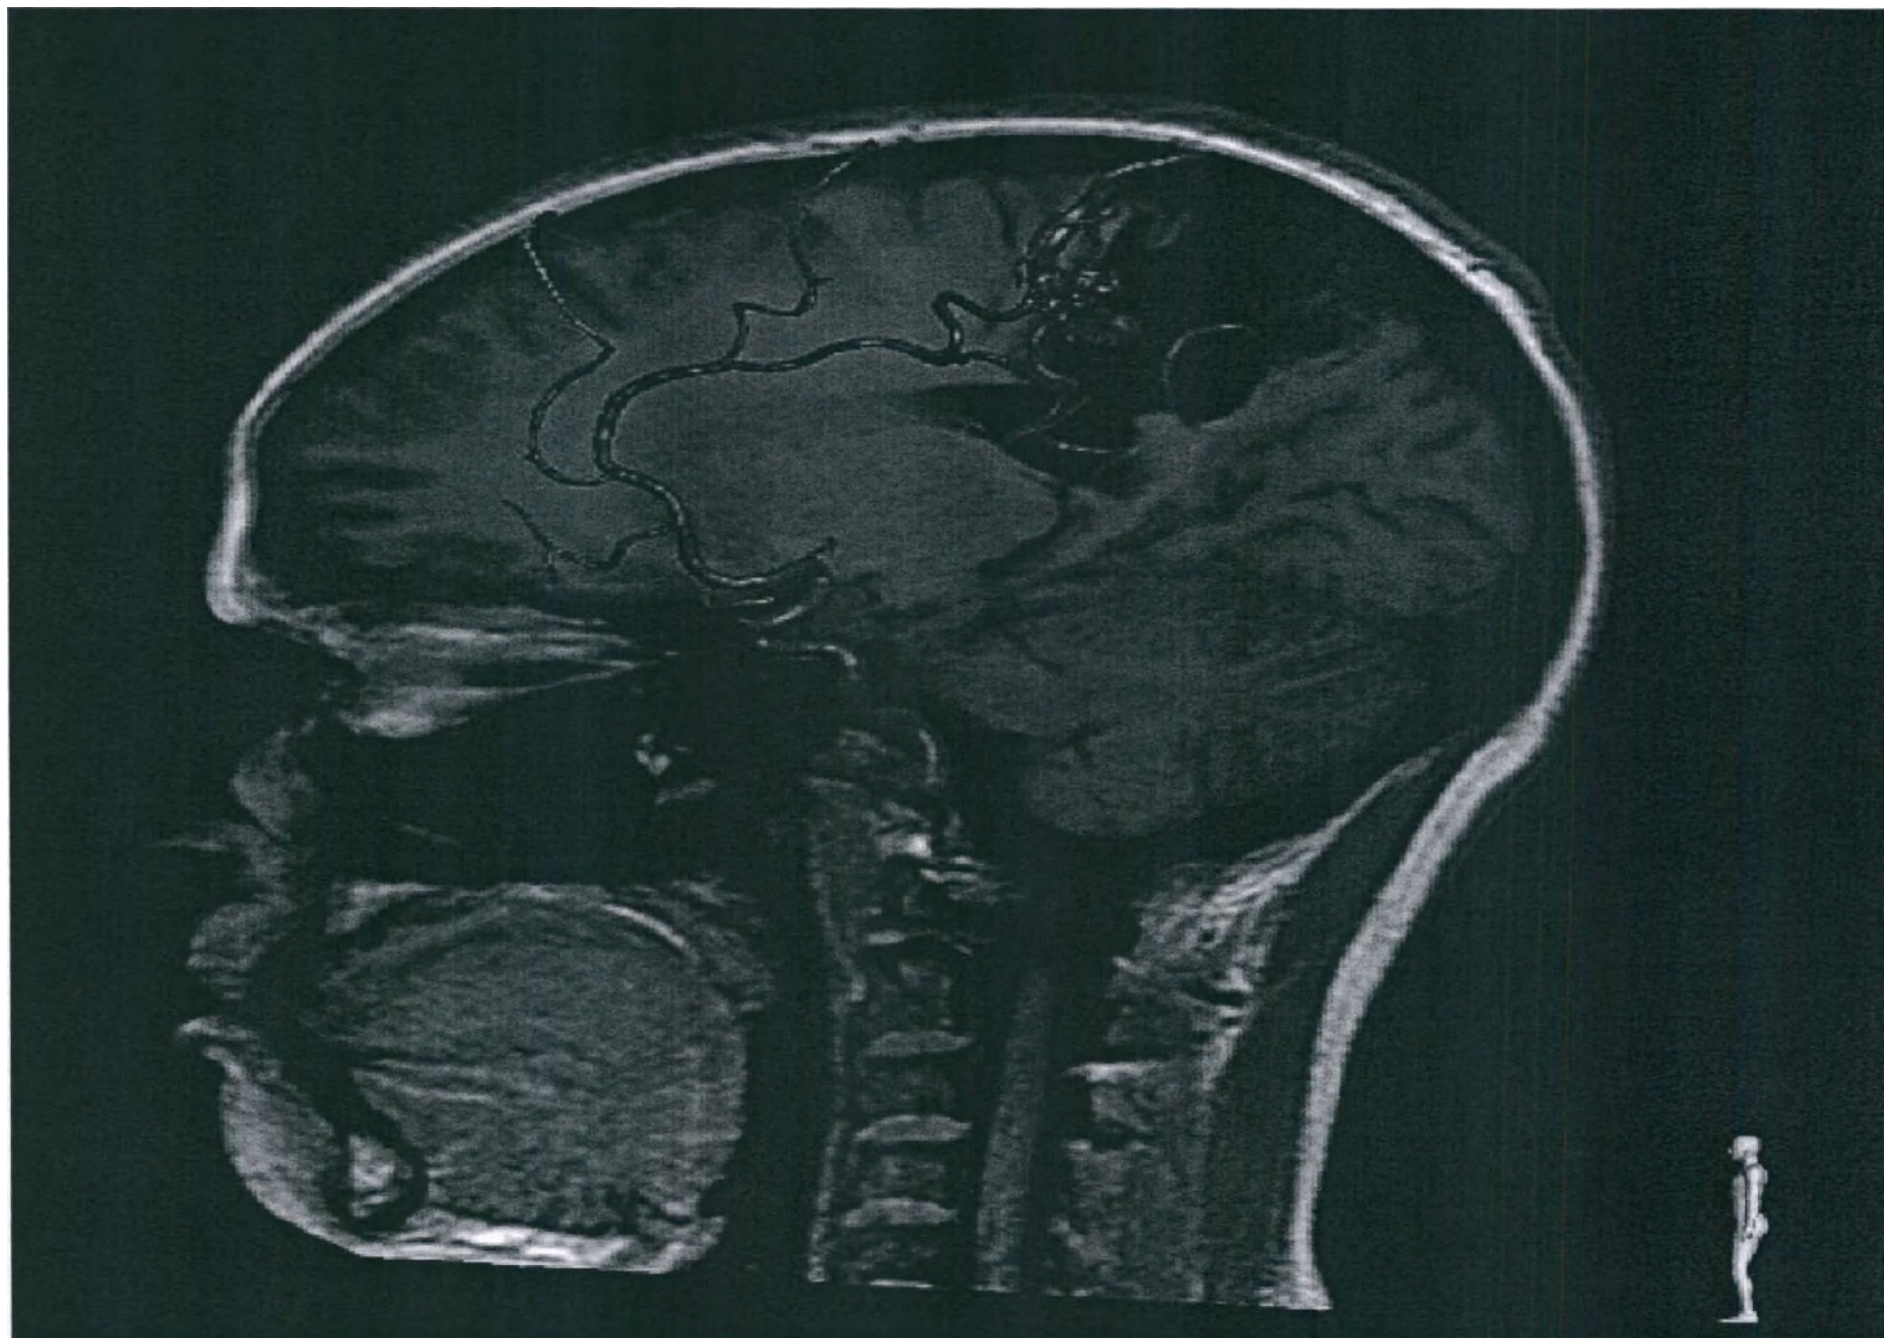

50.к. Модули программные

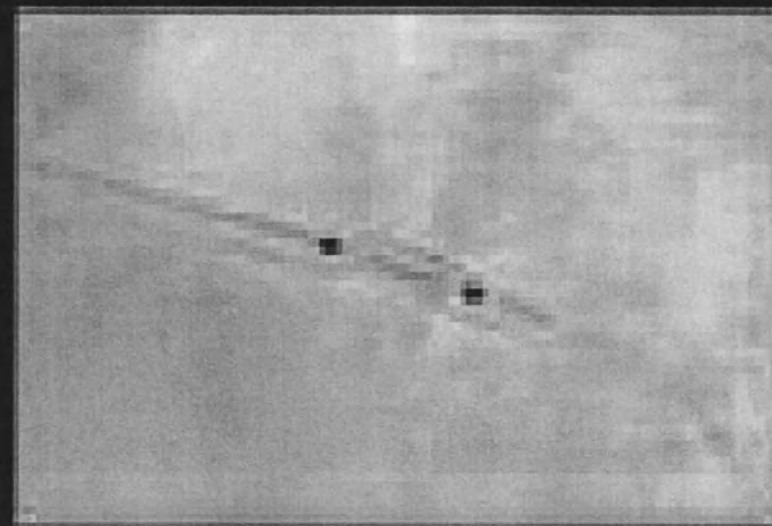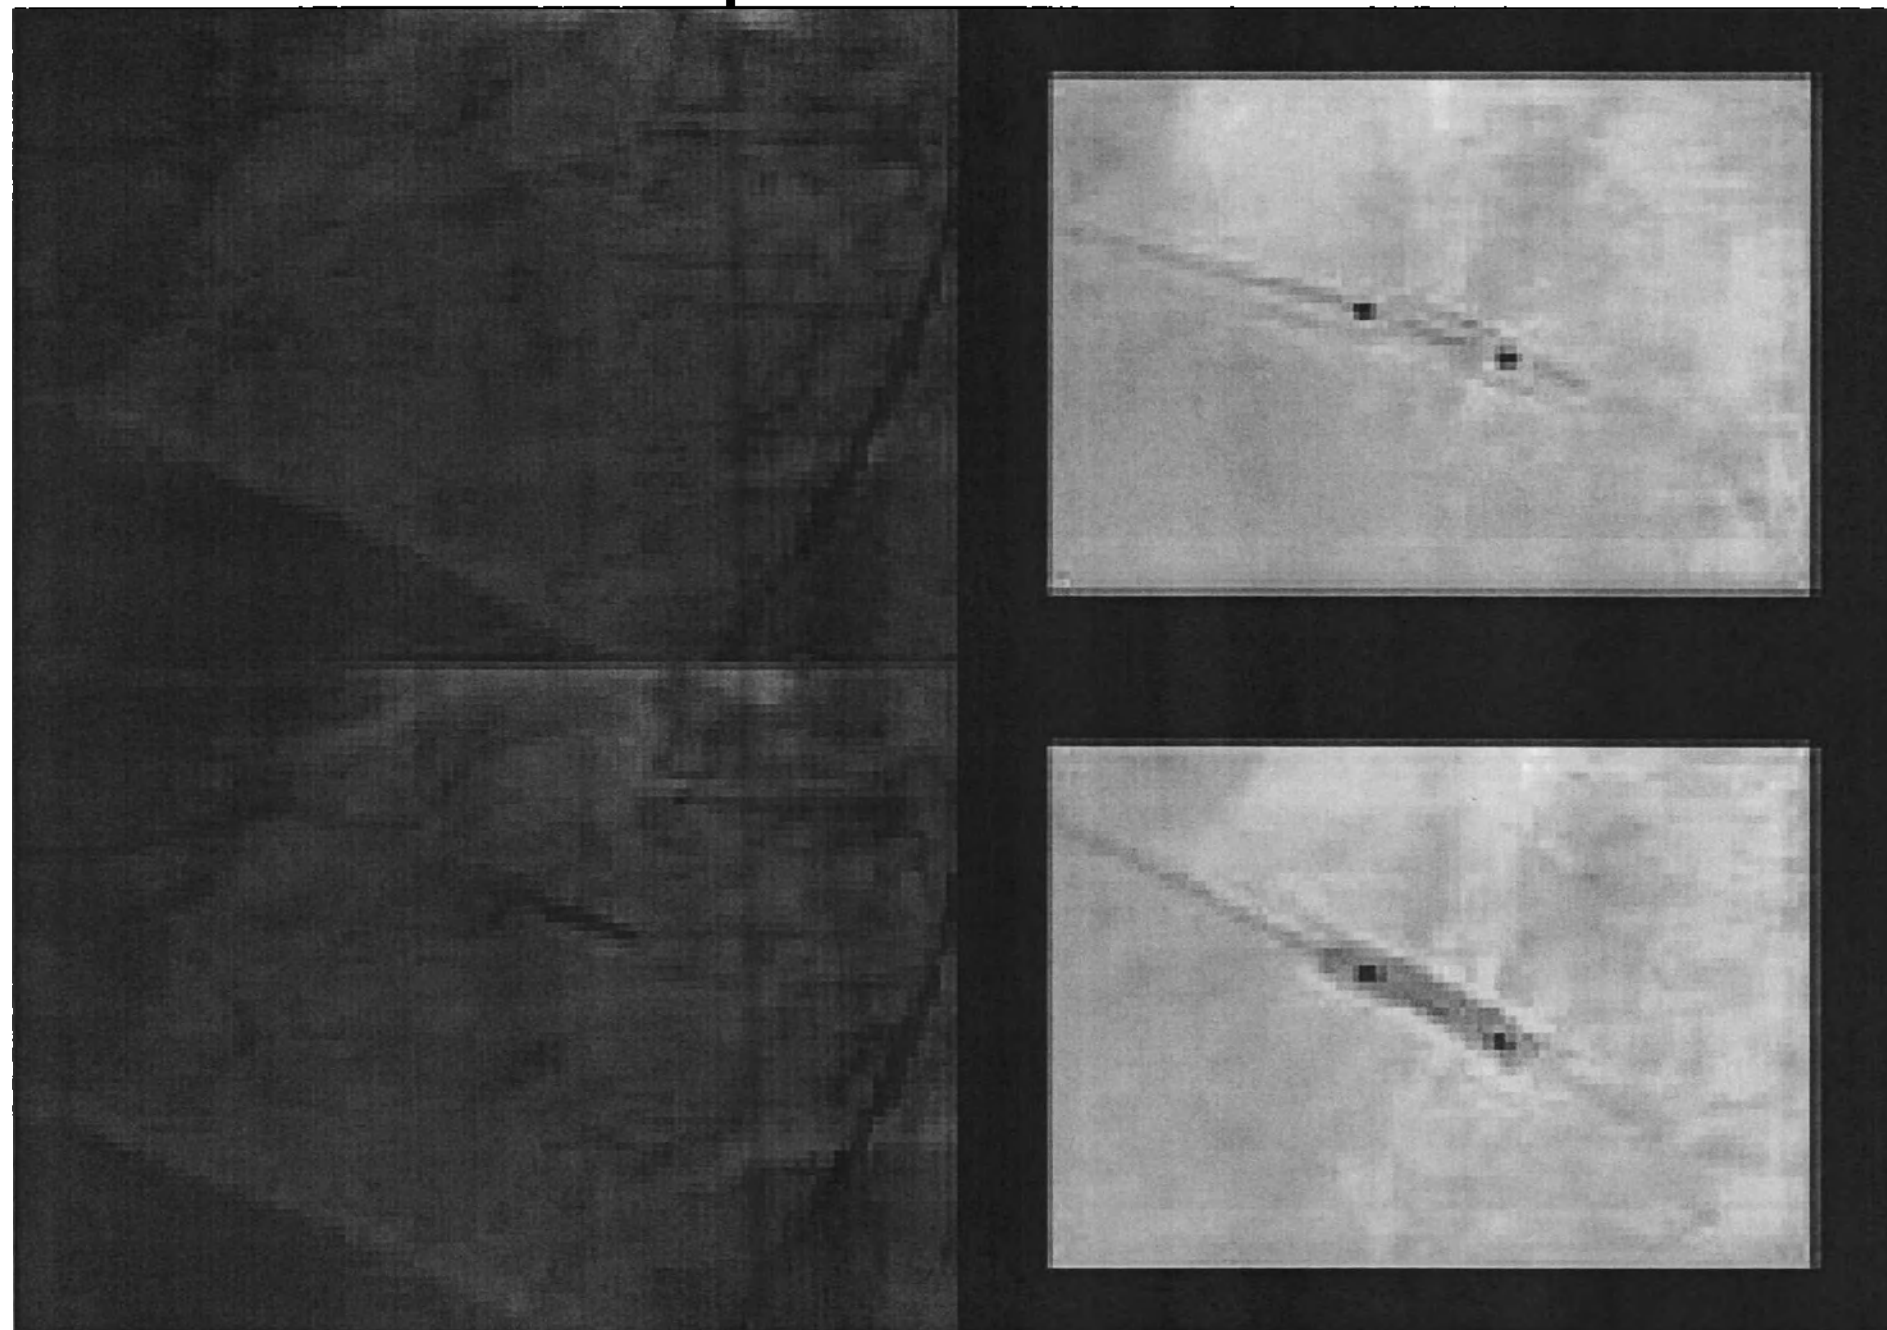


50.л. Модули программные

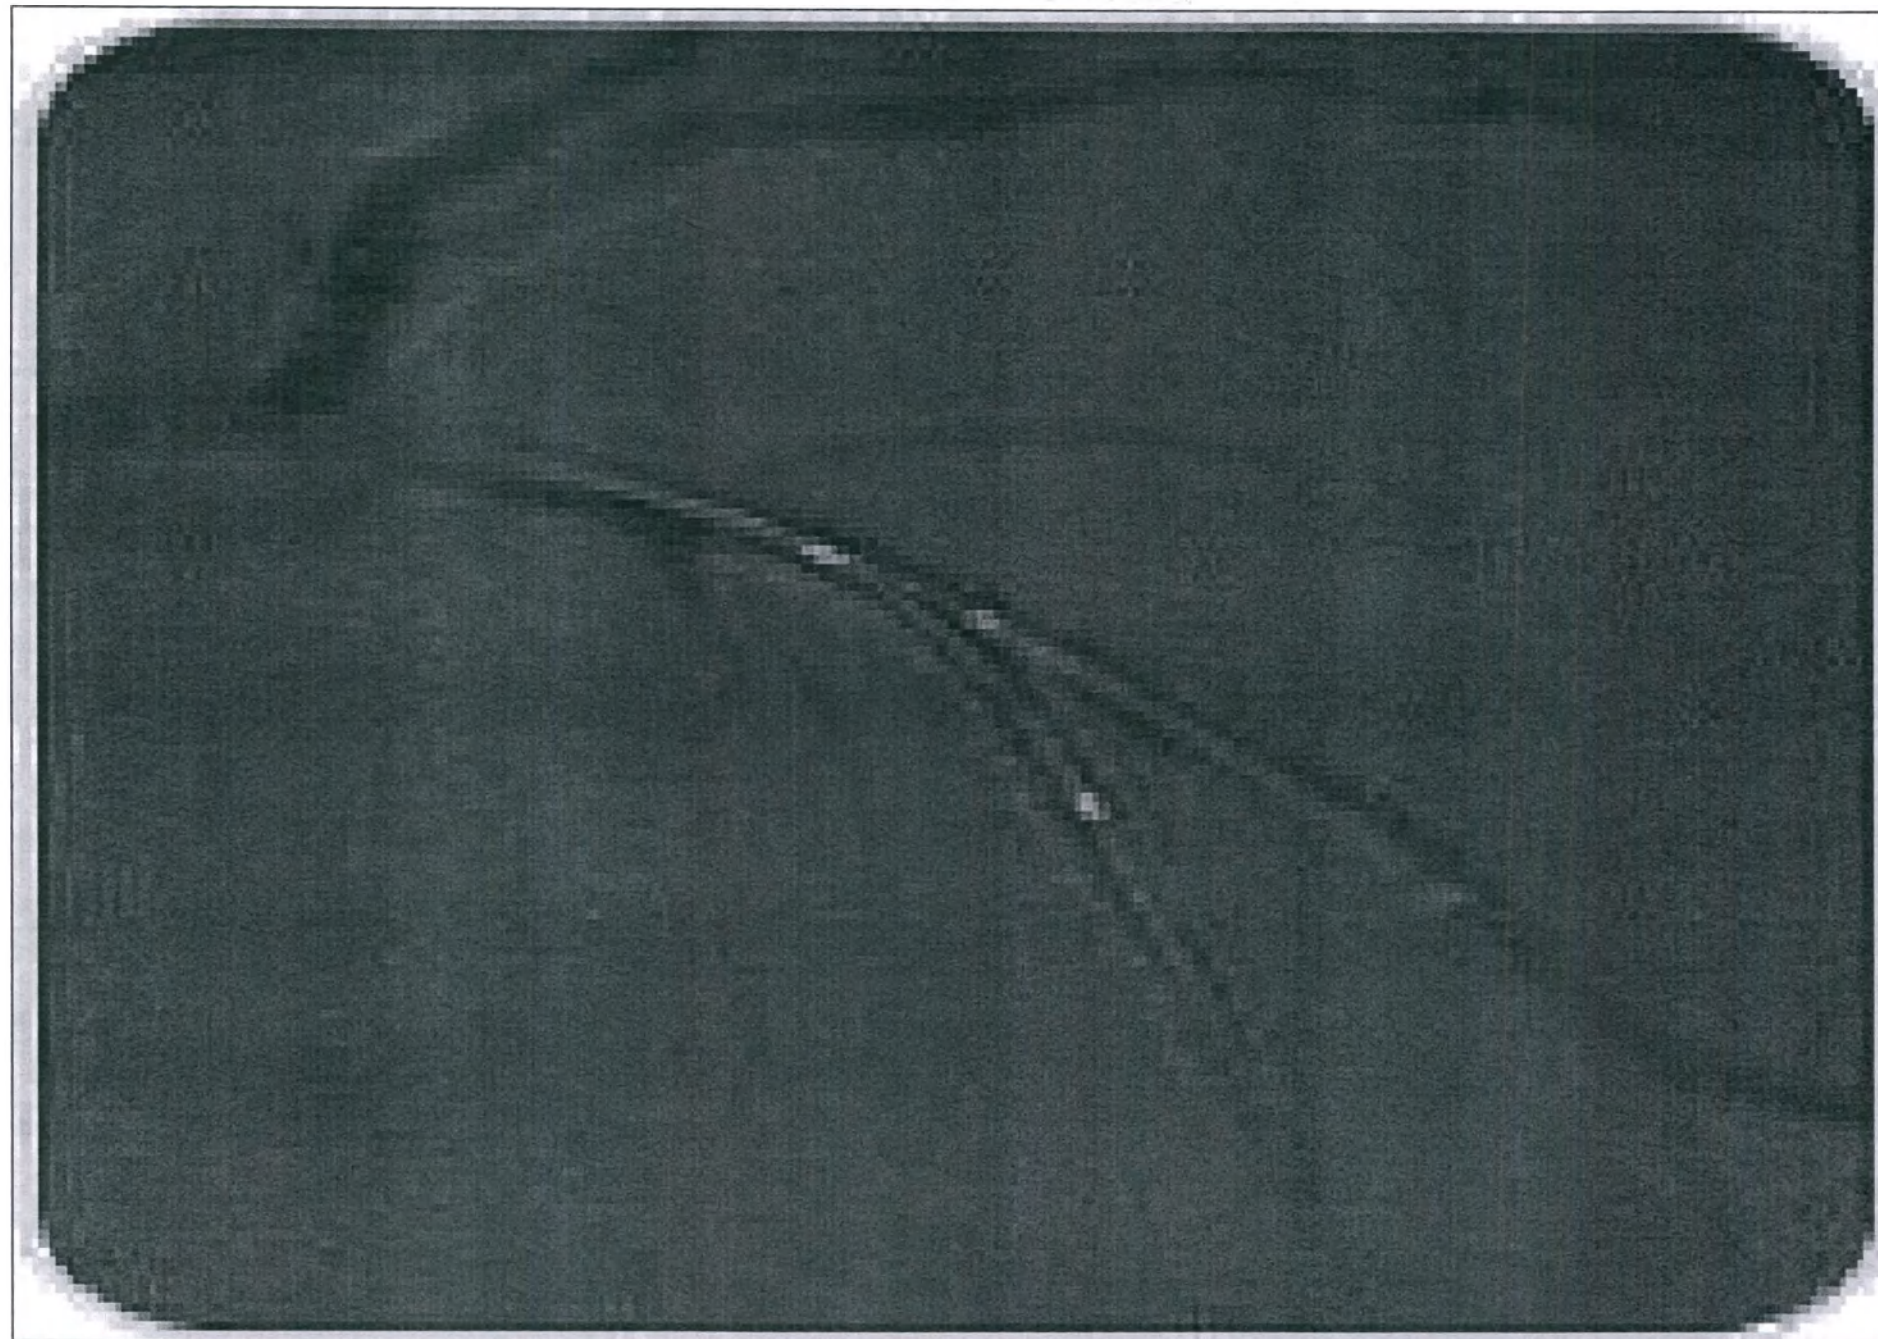


50.м. Модули программные




50.н. Модули программные

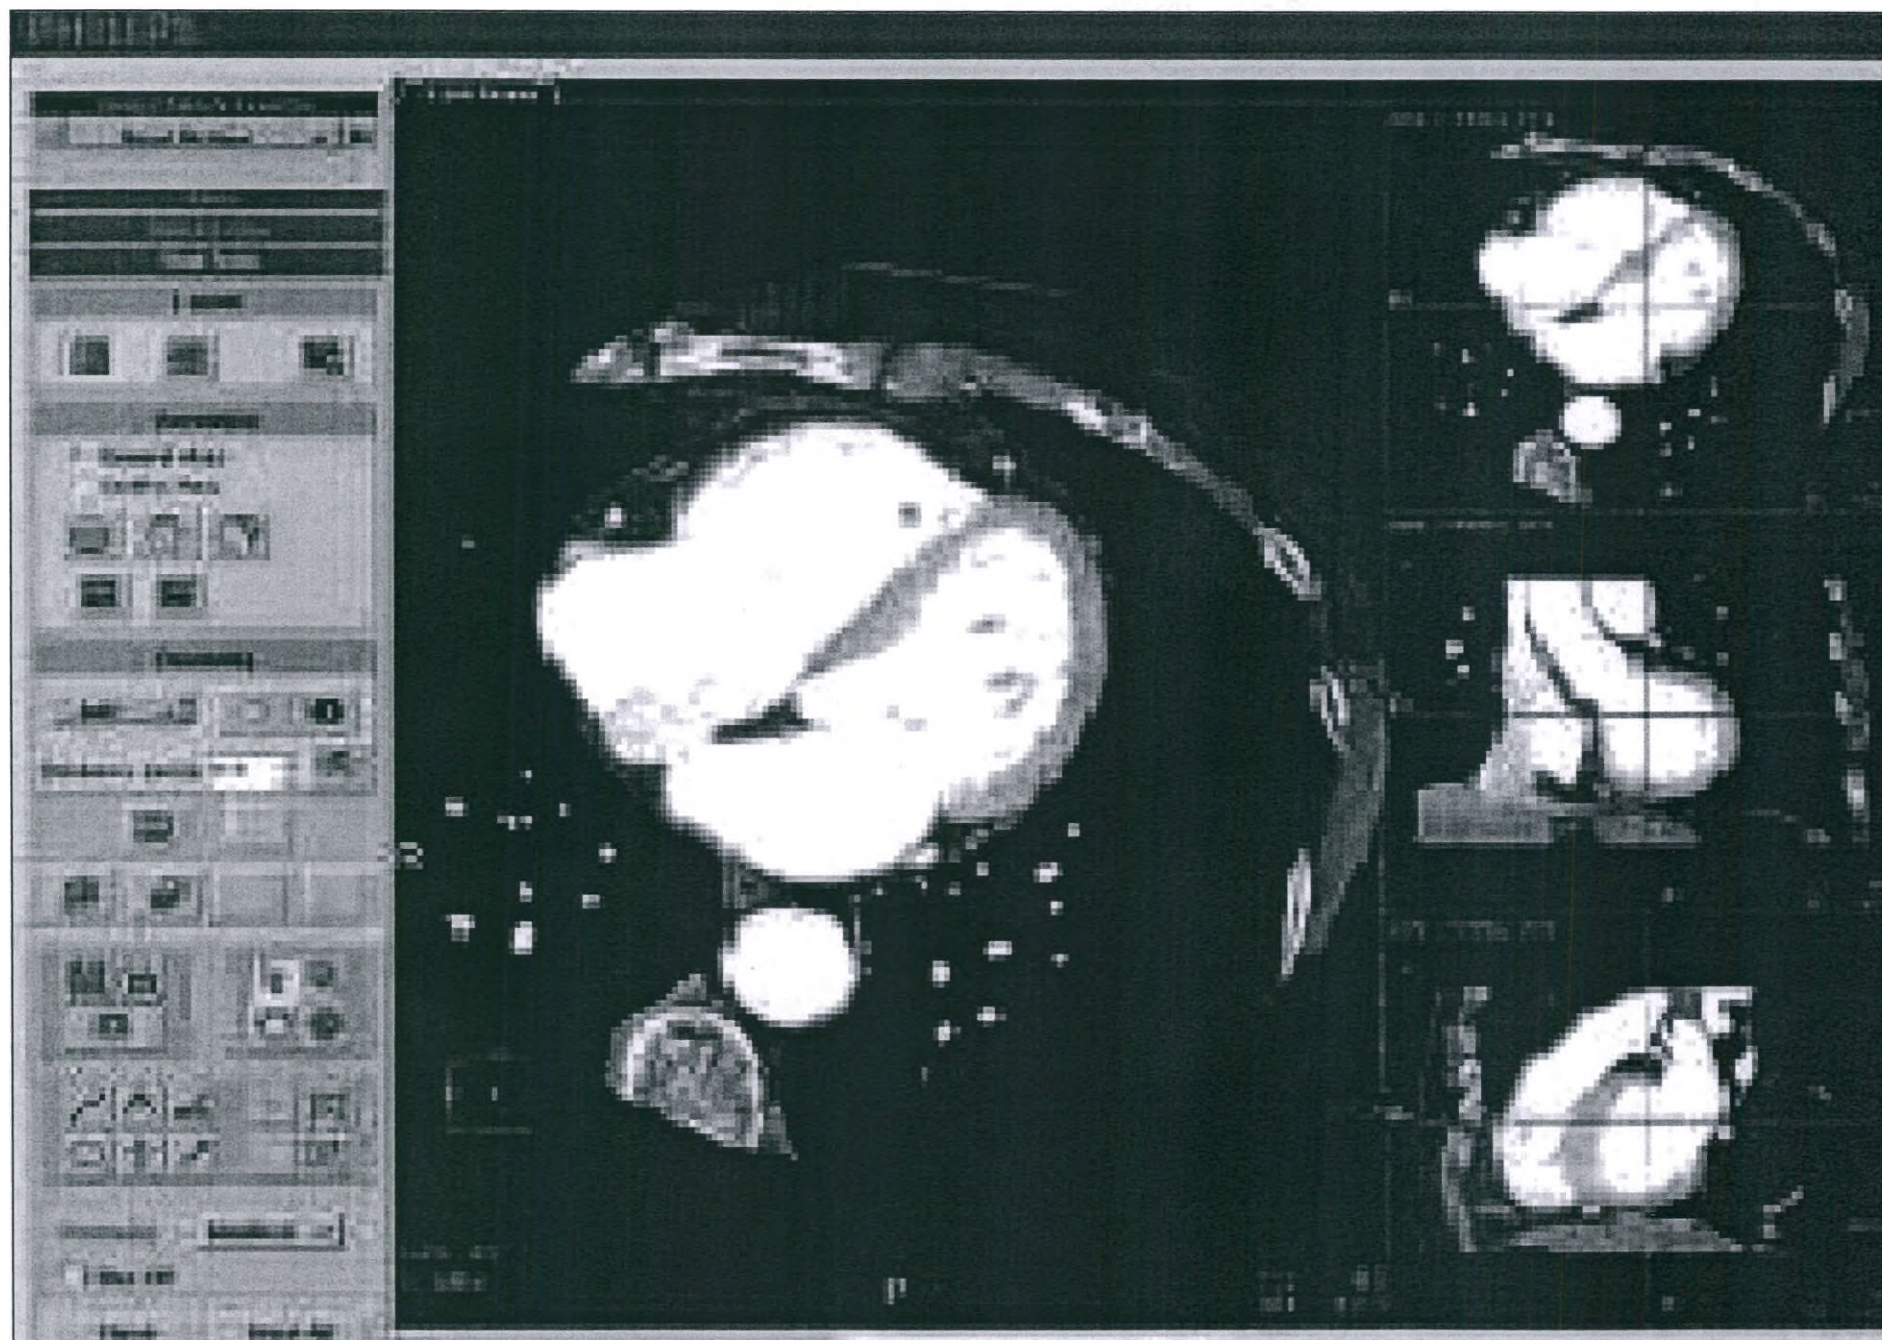


50.о. Модули программные

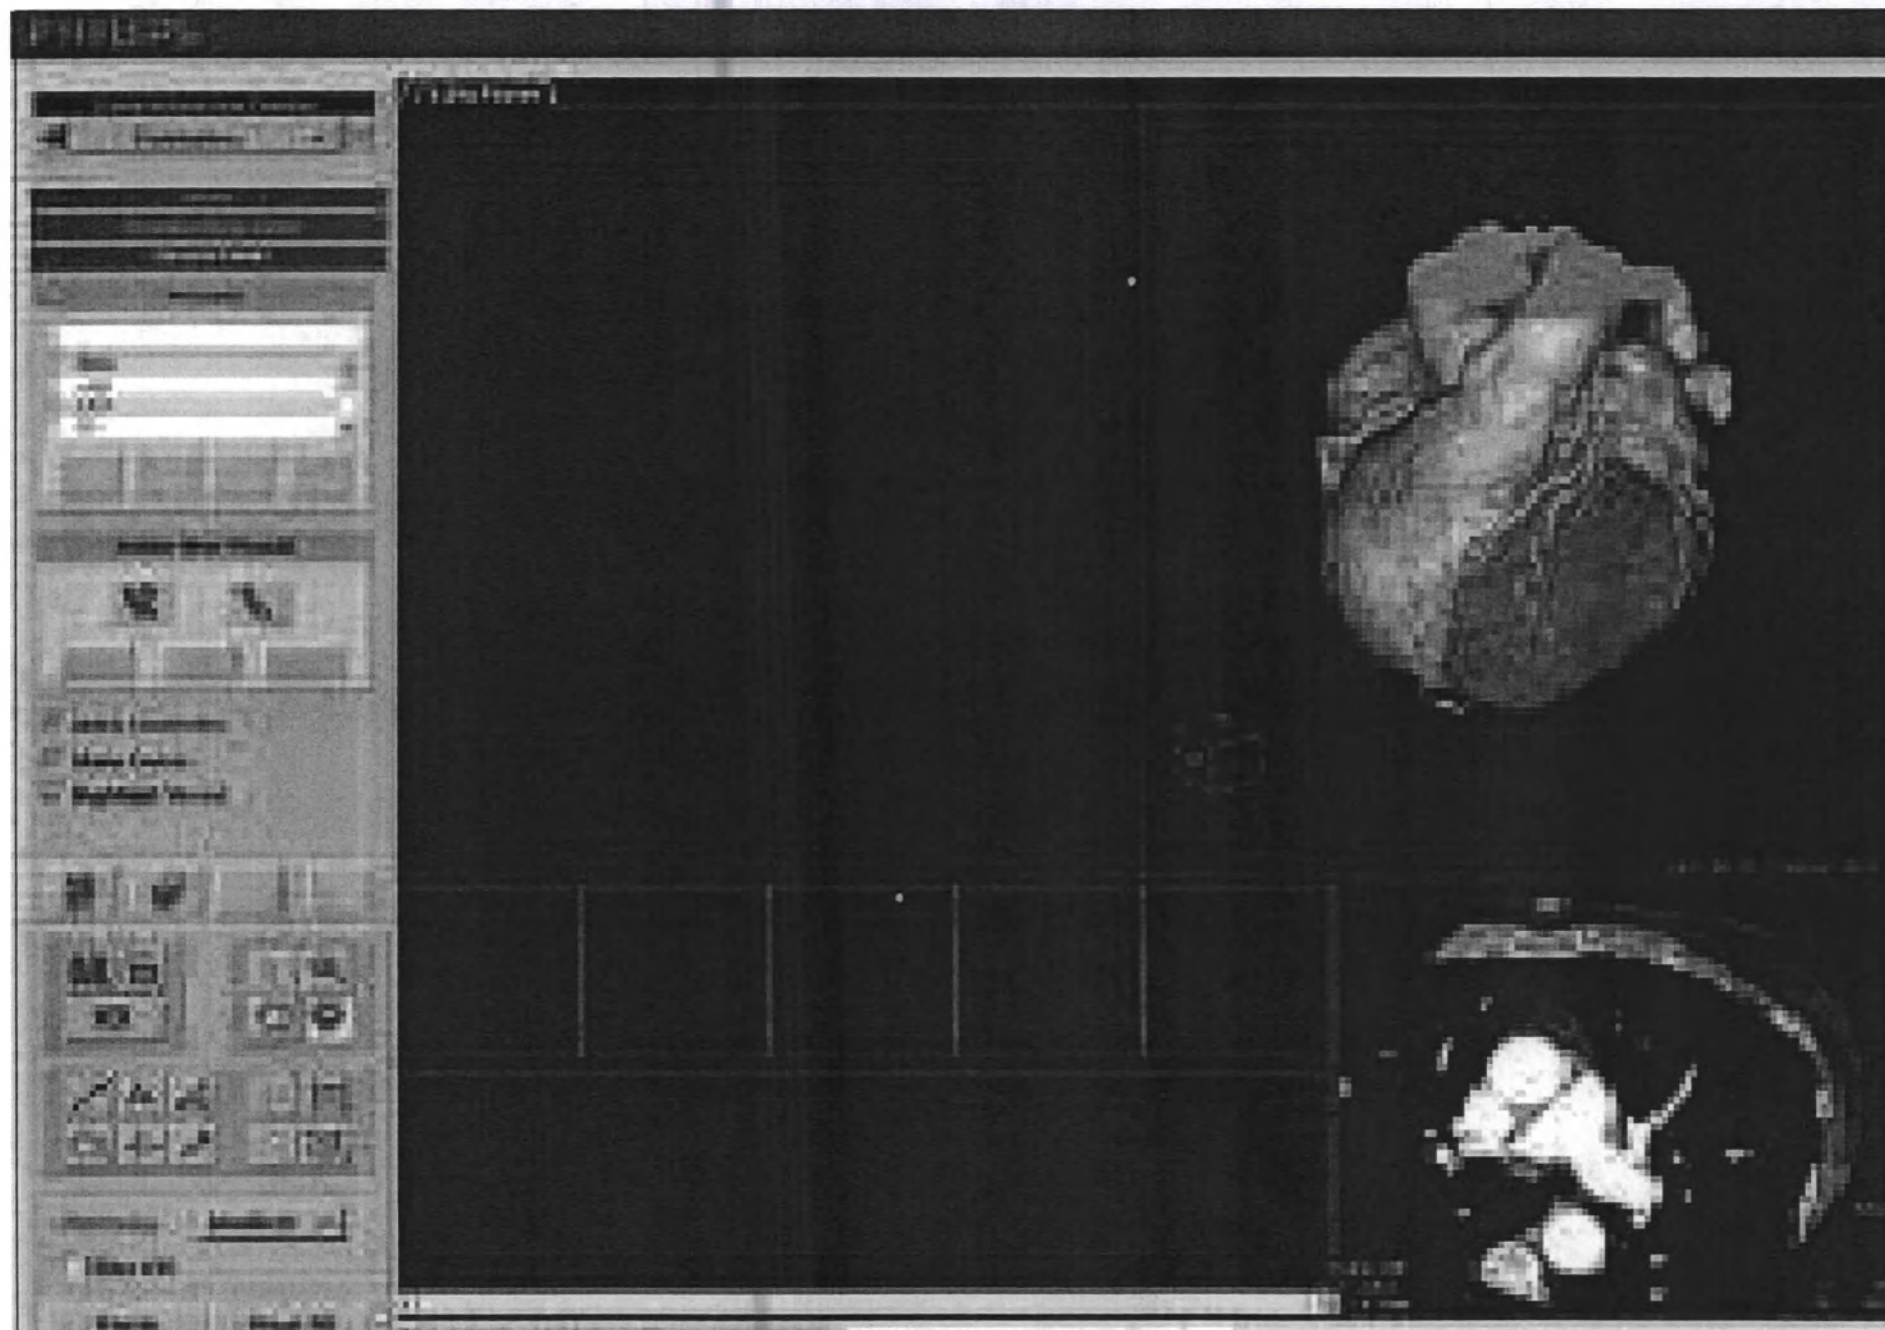


50.п. Модули программные

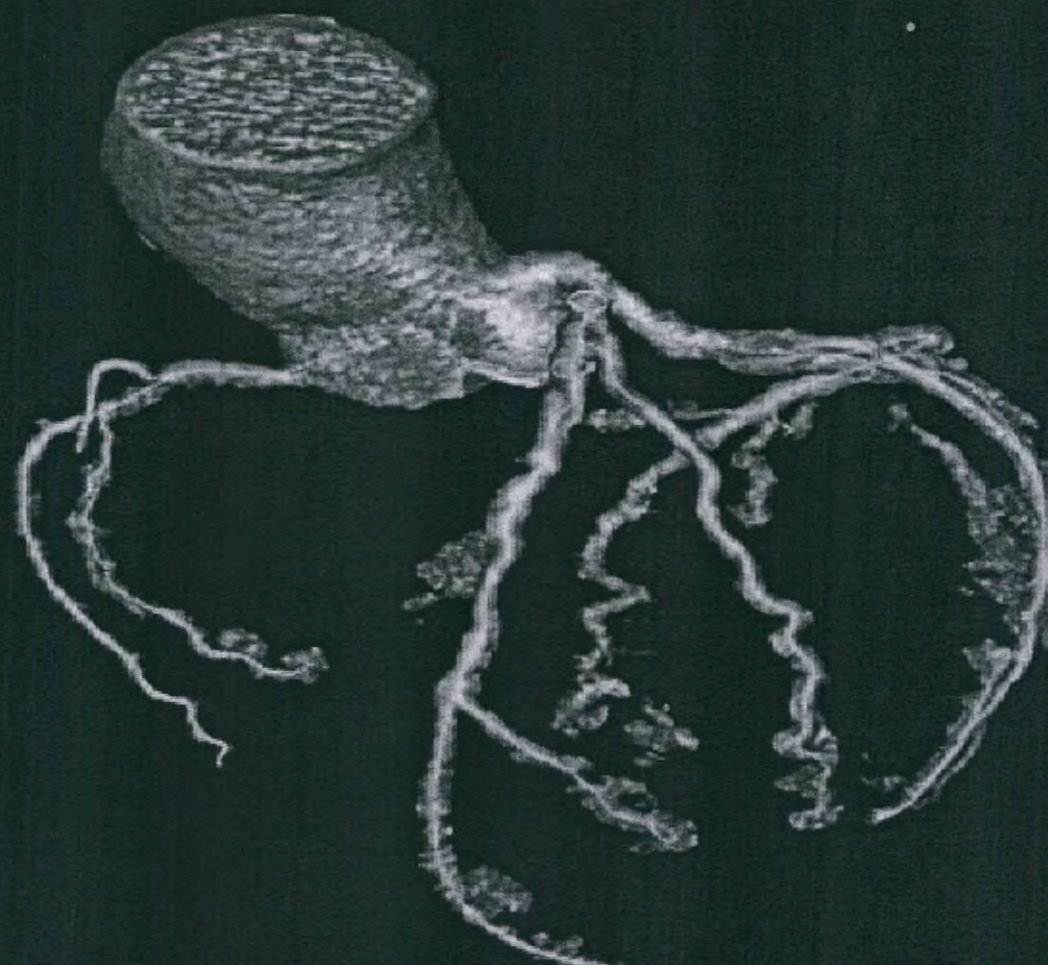


Länge des gewählten Segments: 16.7 mm

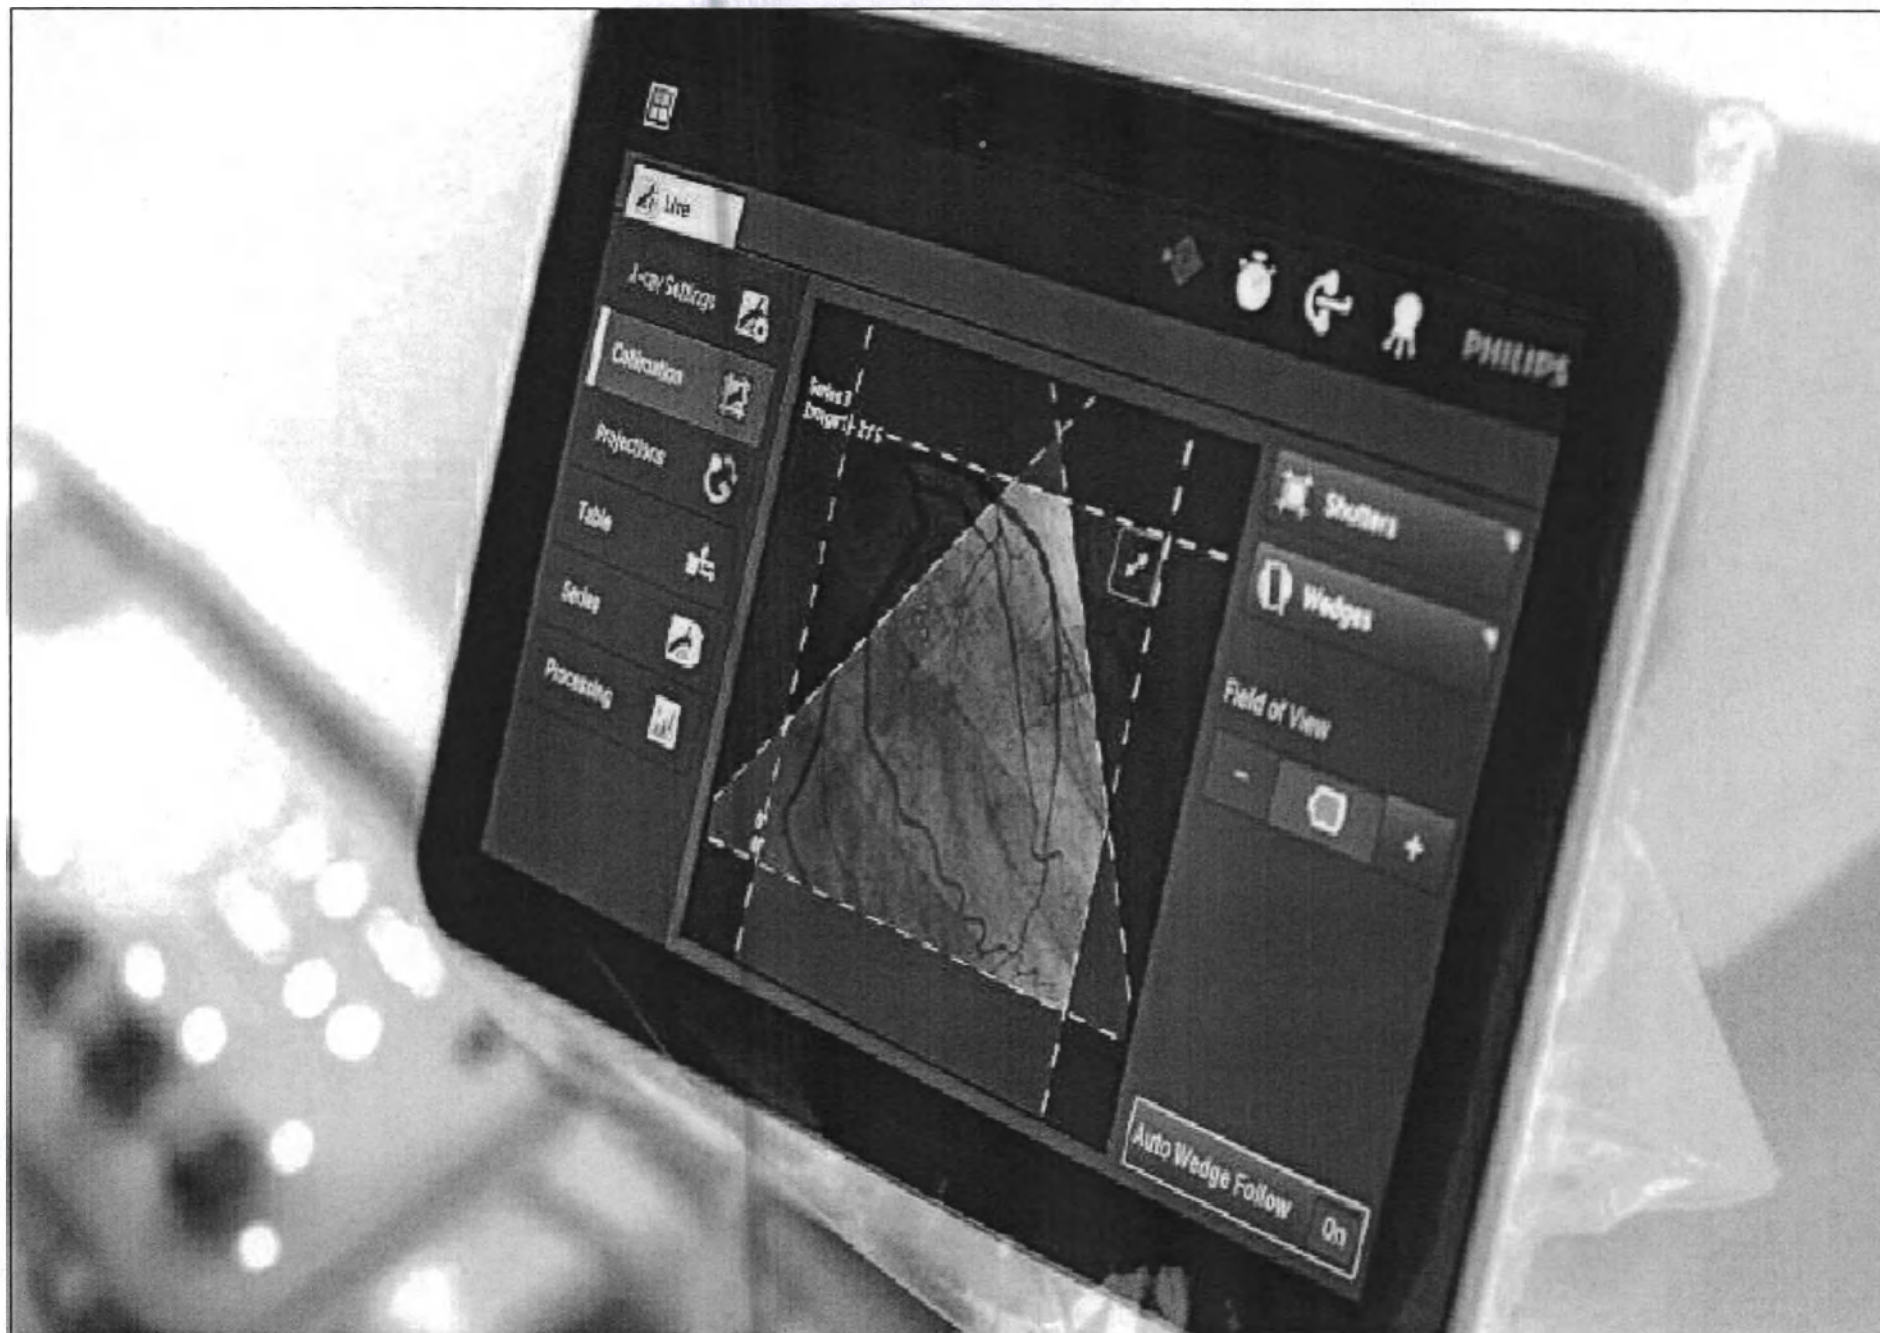

50.с. Модули программные

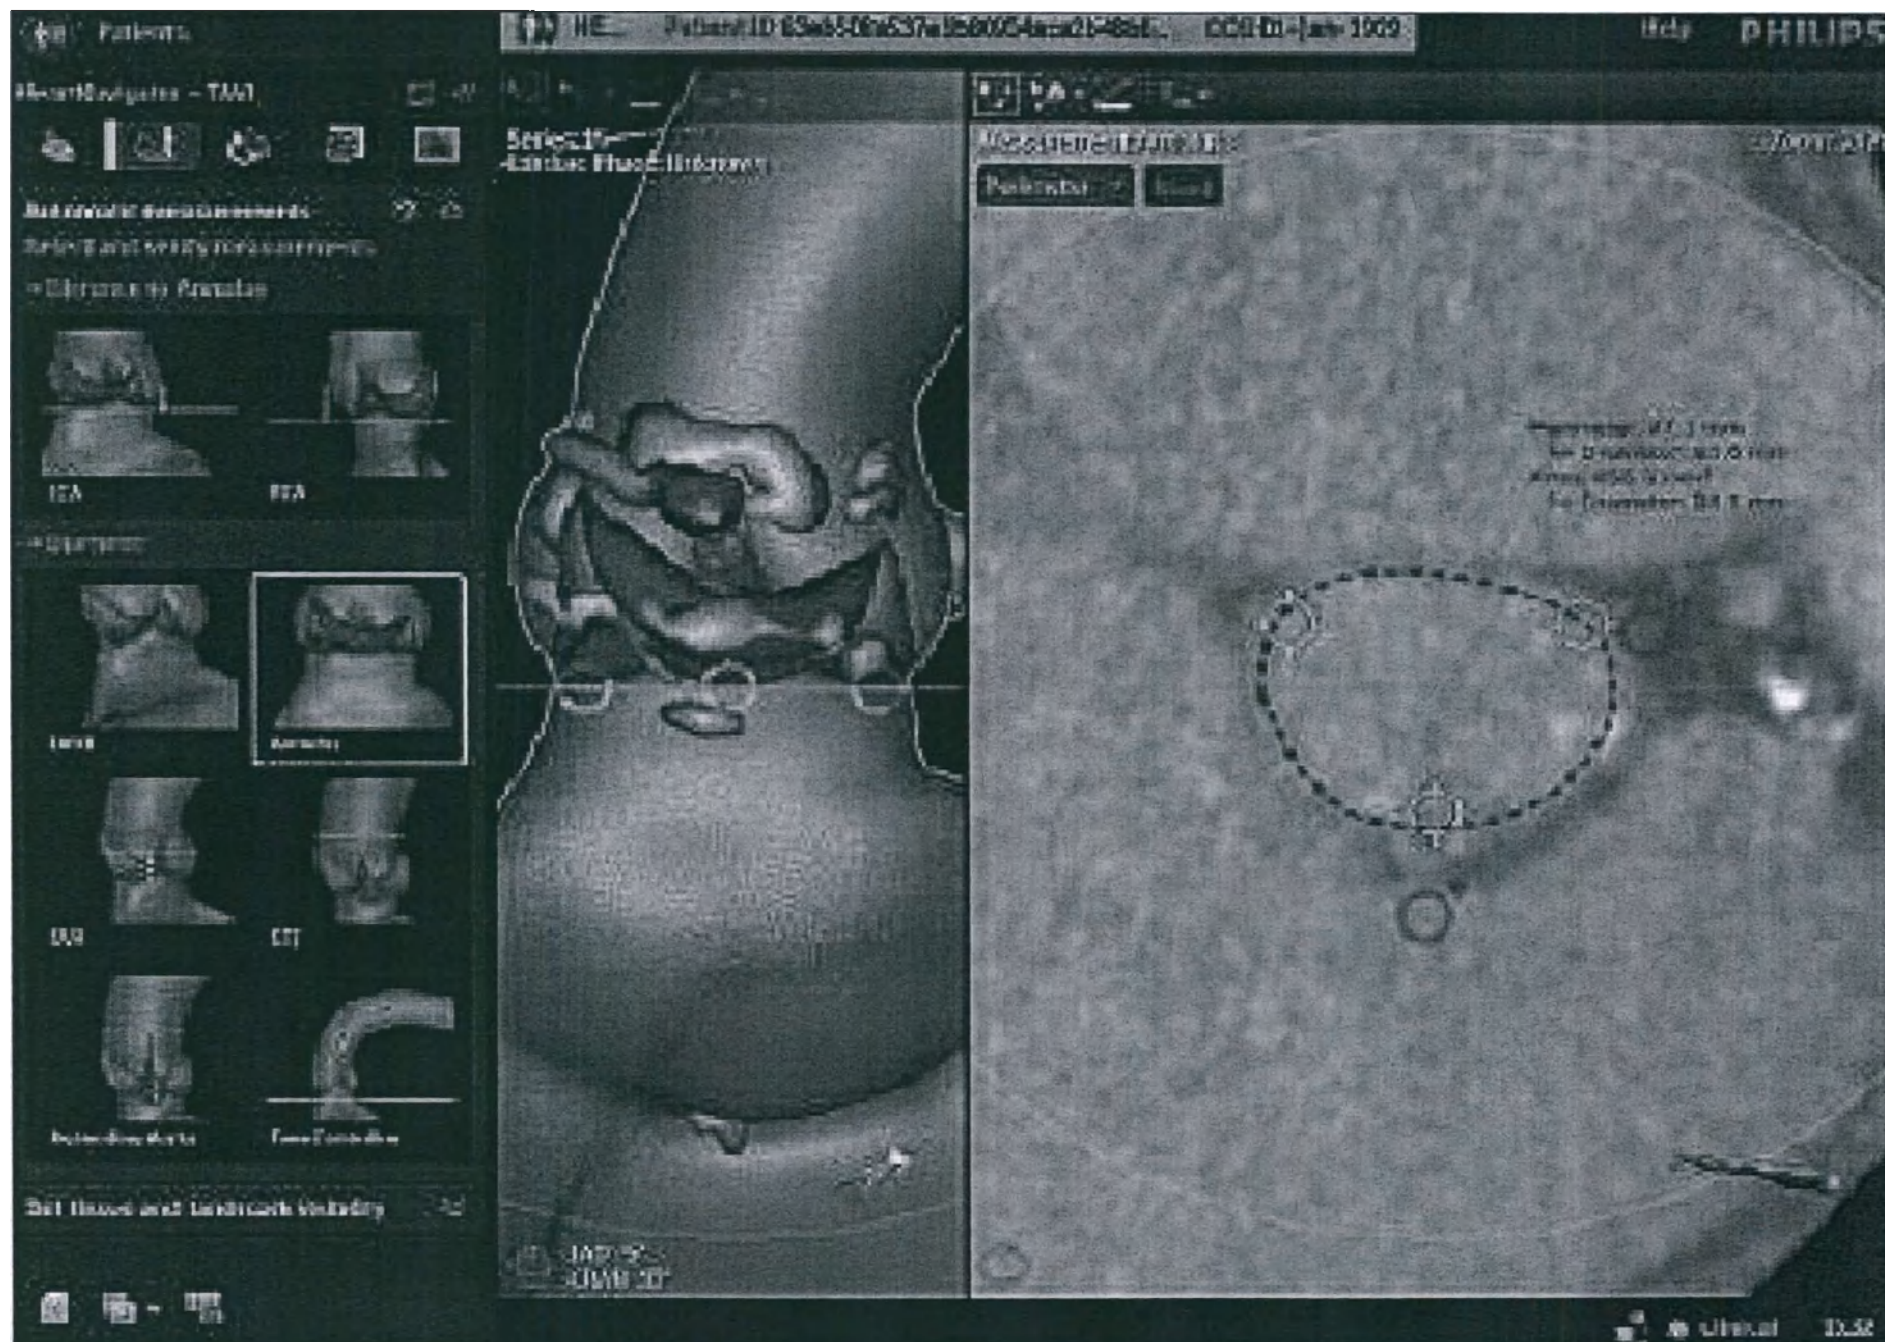


50.т. Модули программные

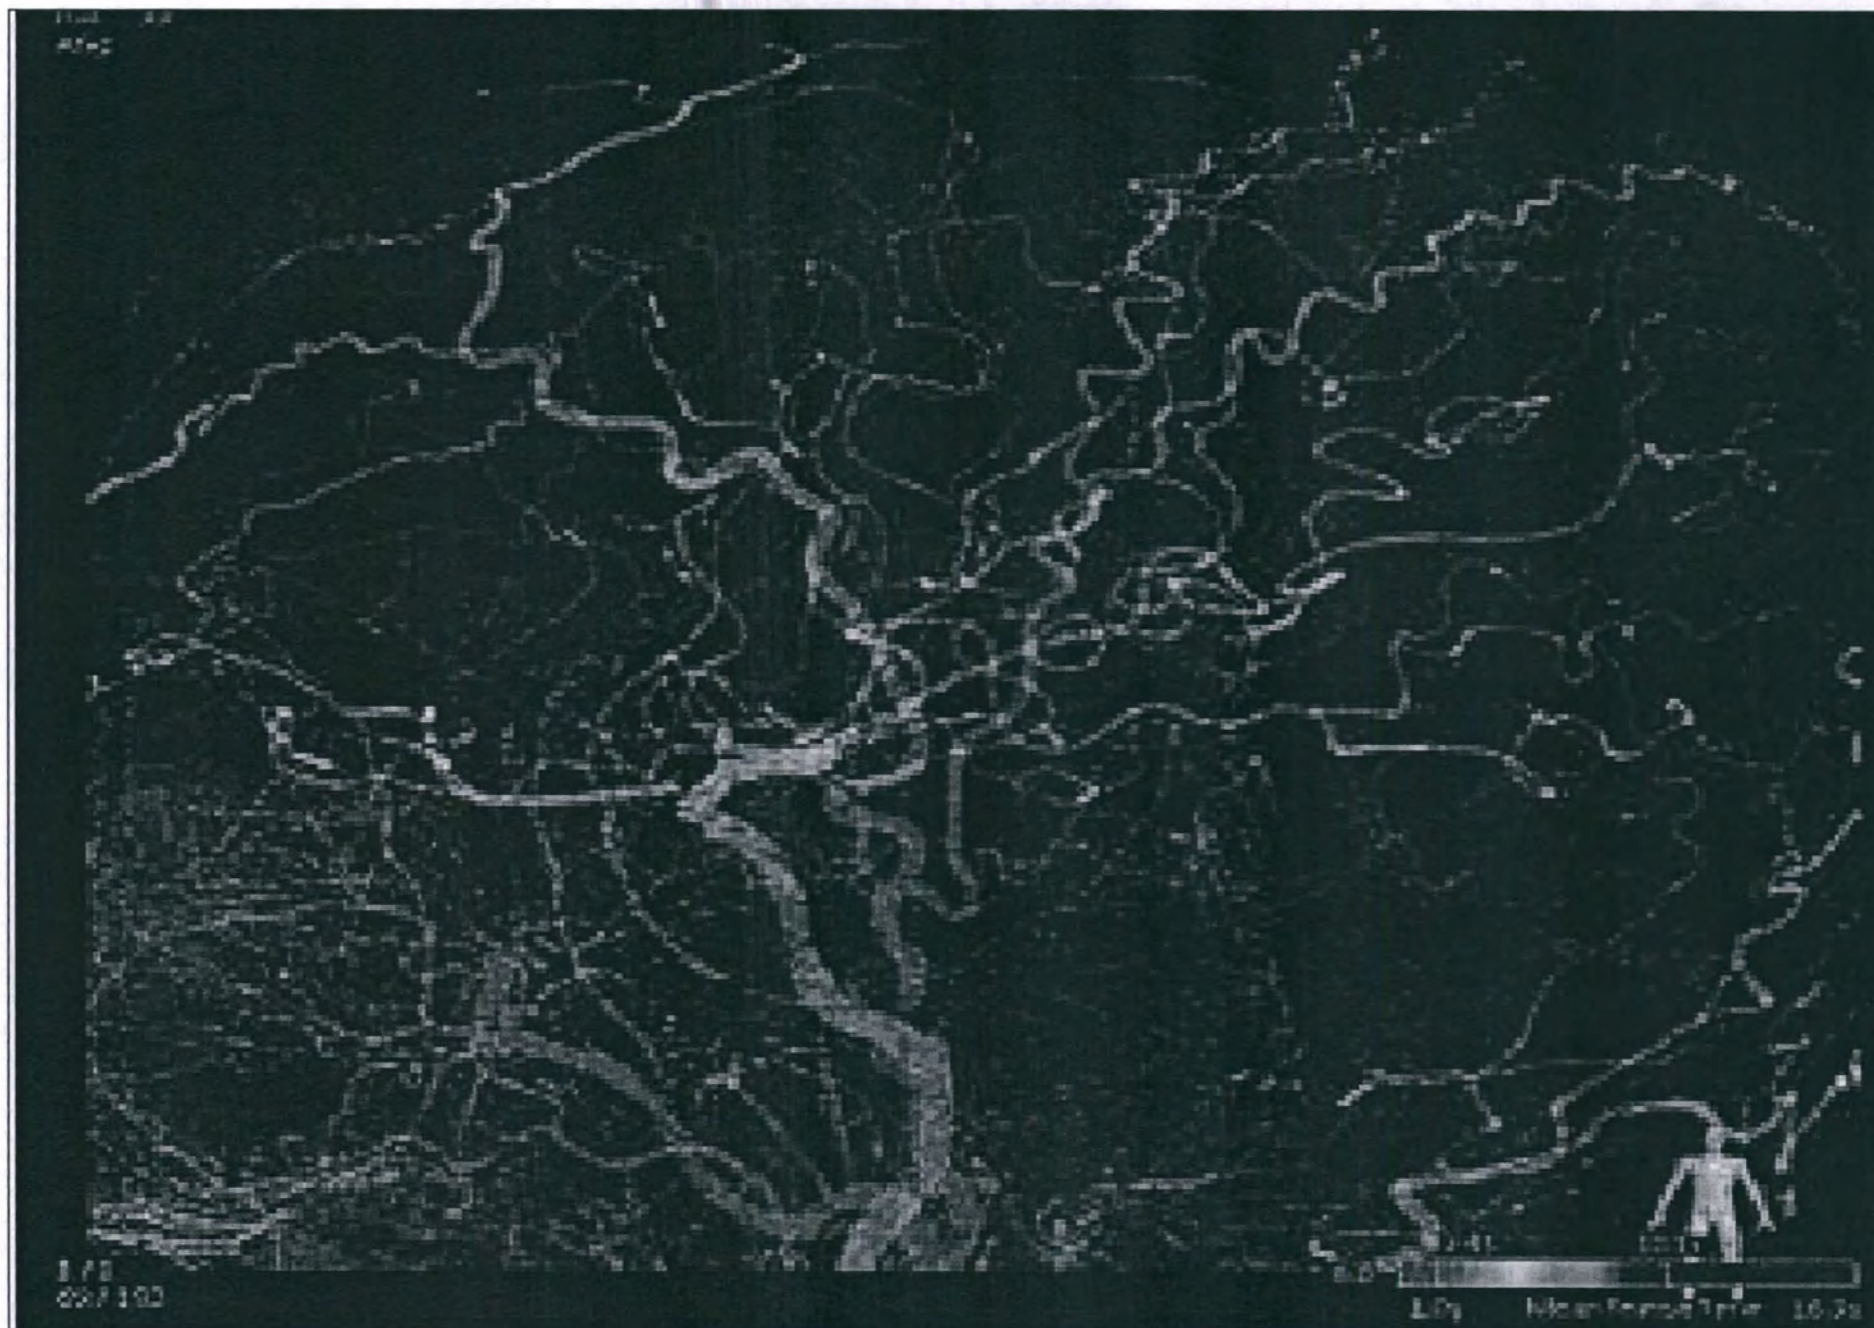


50.у. Модули программные




50.ф. Модули программные

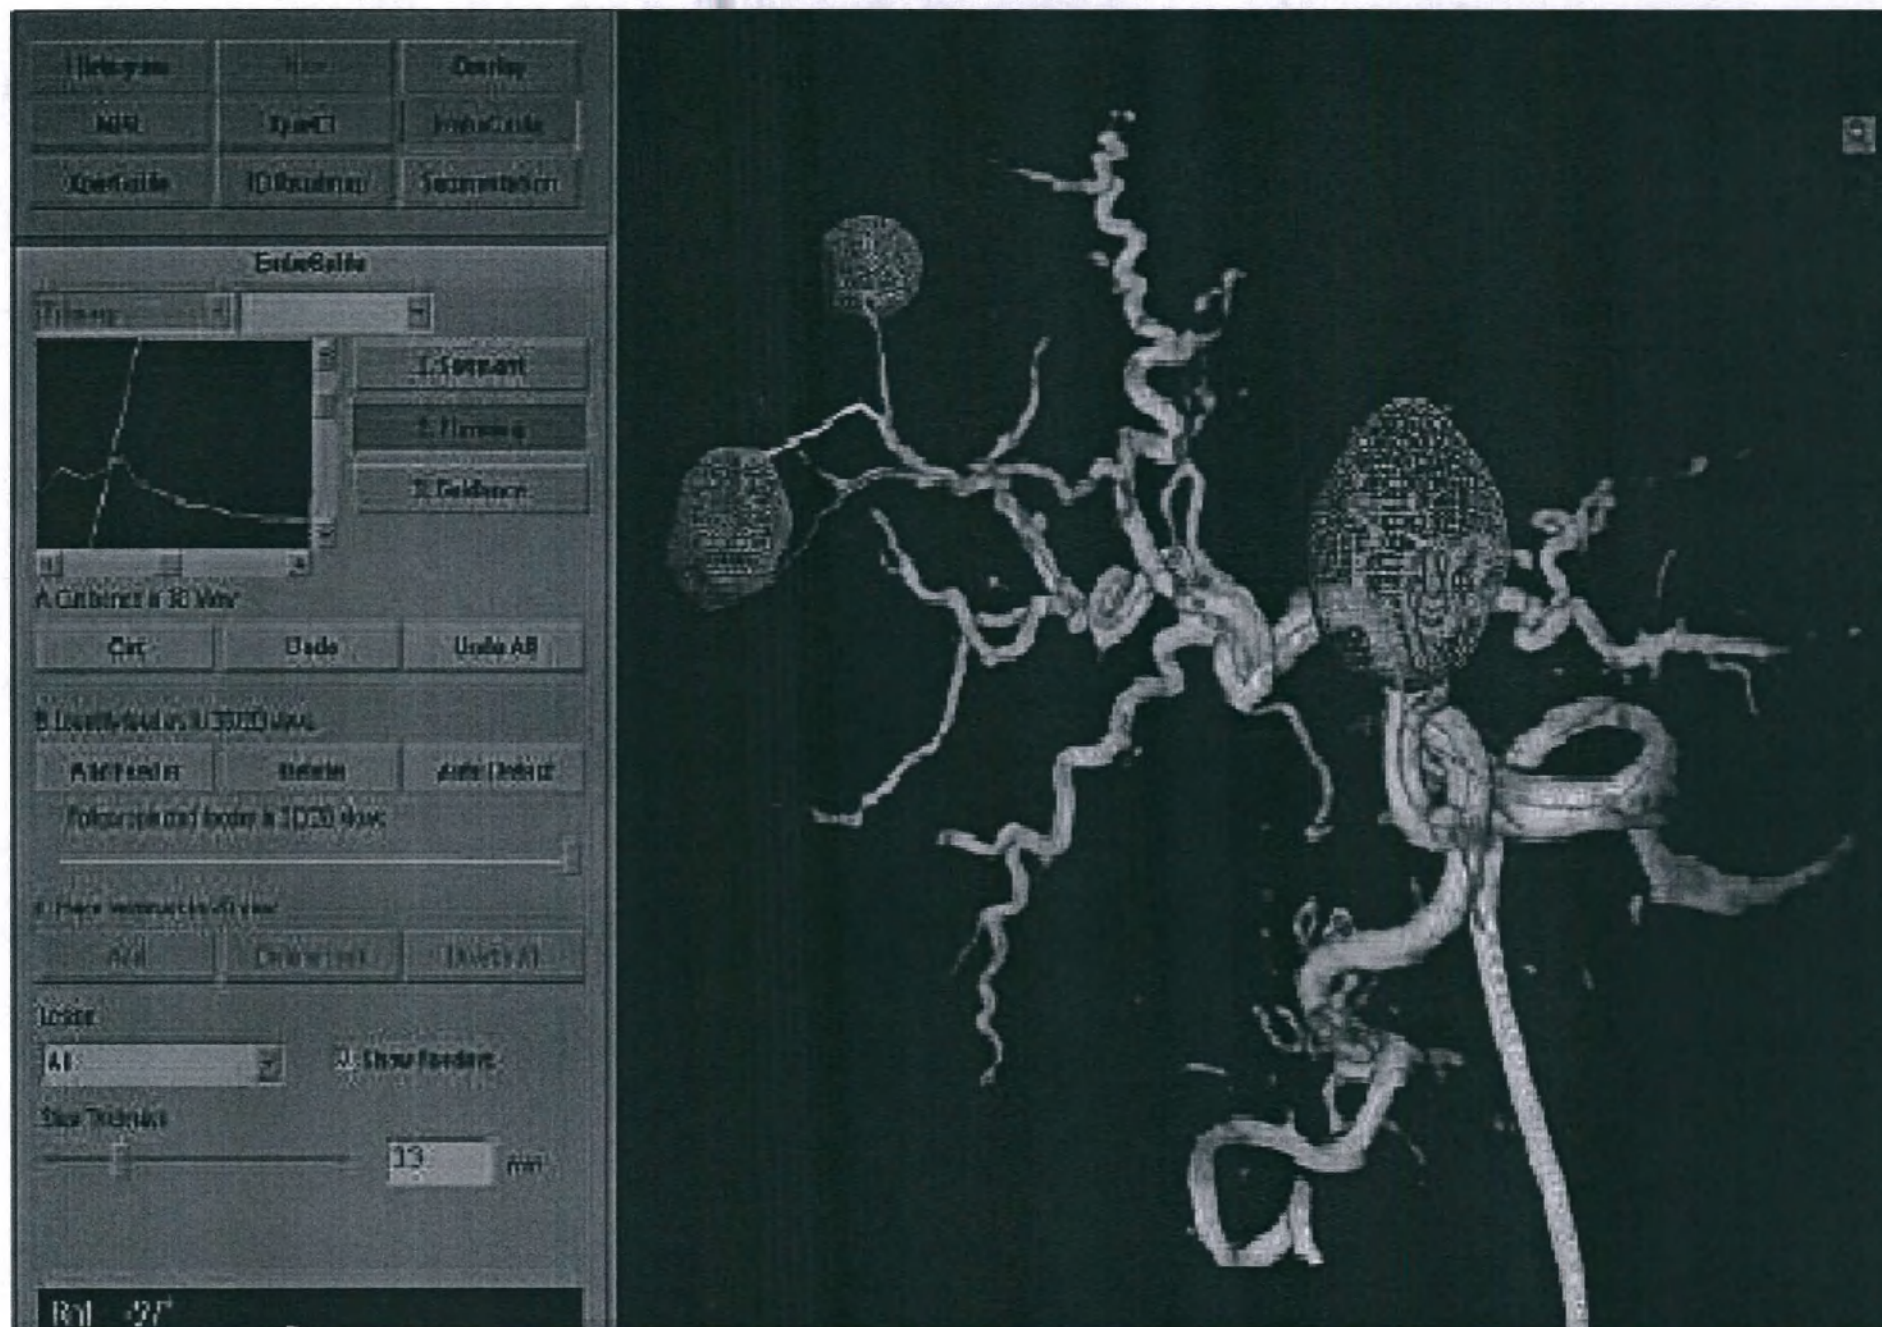

50.x. Модули программные

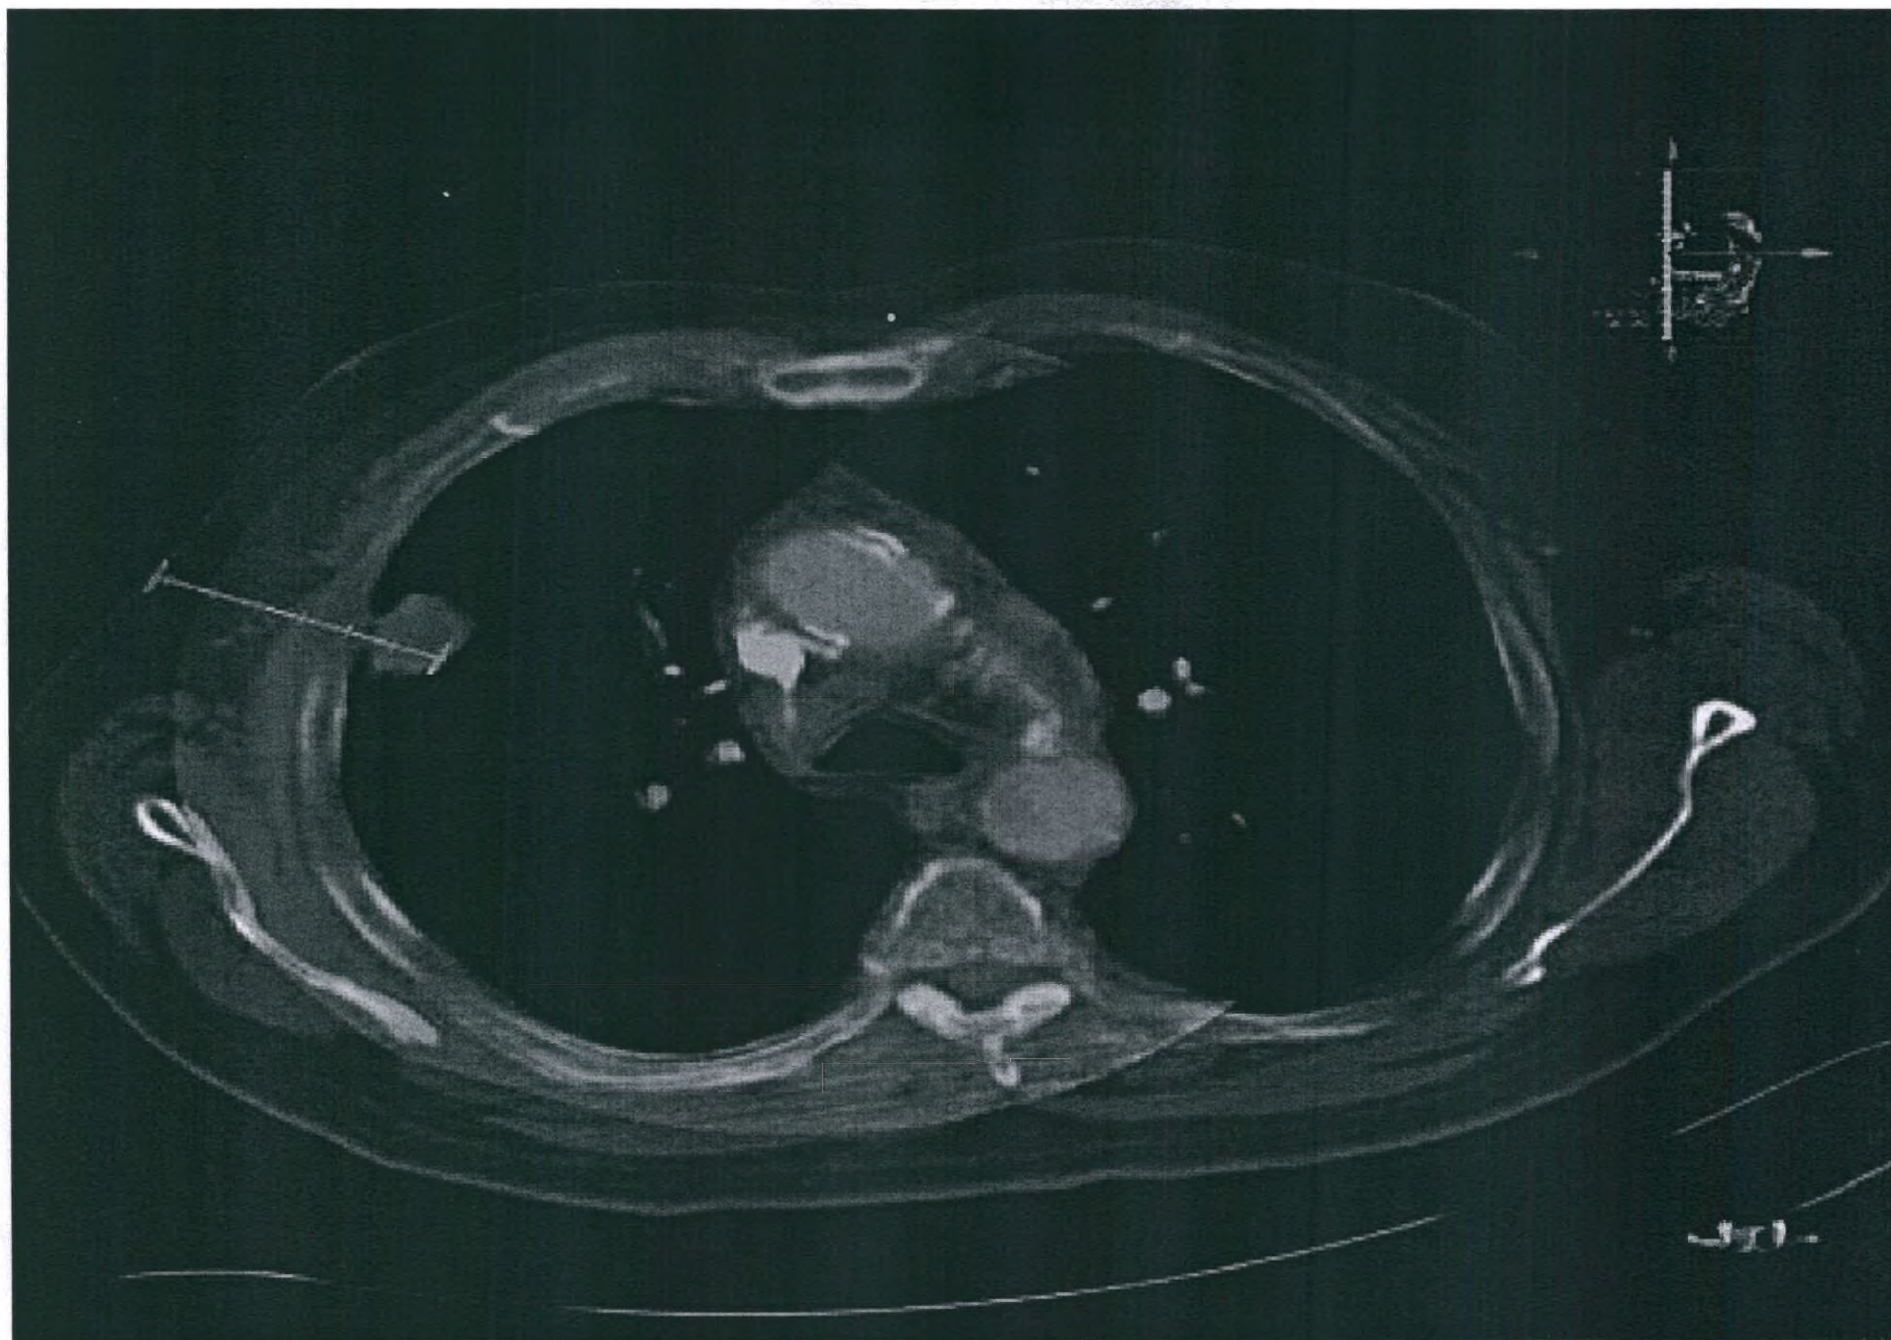

50.ц. Модули программные

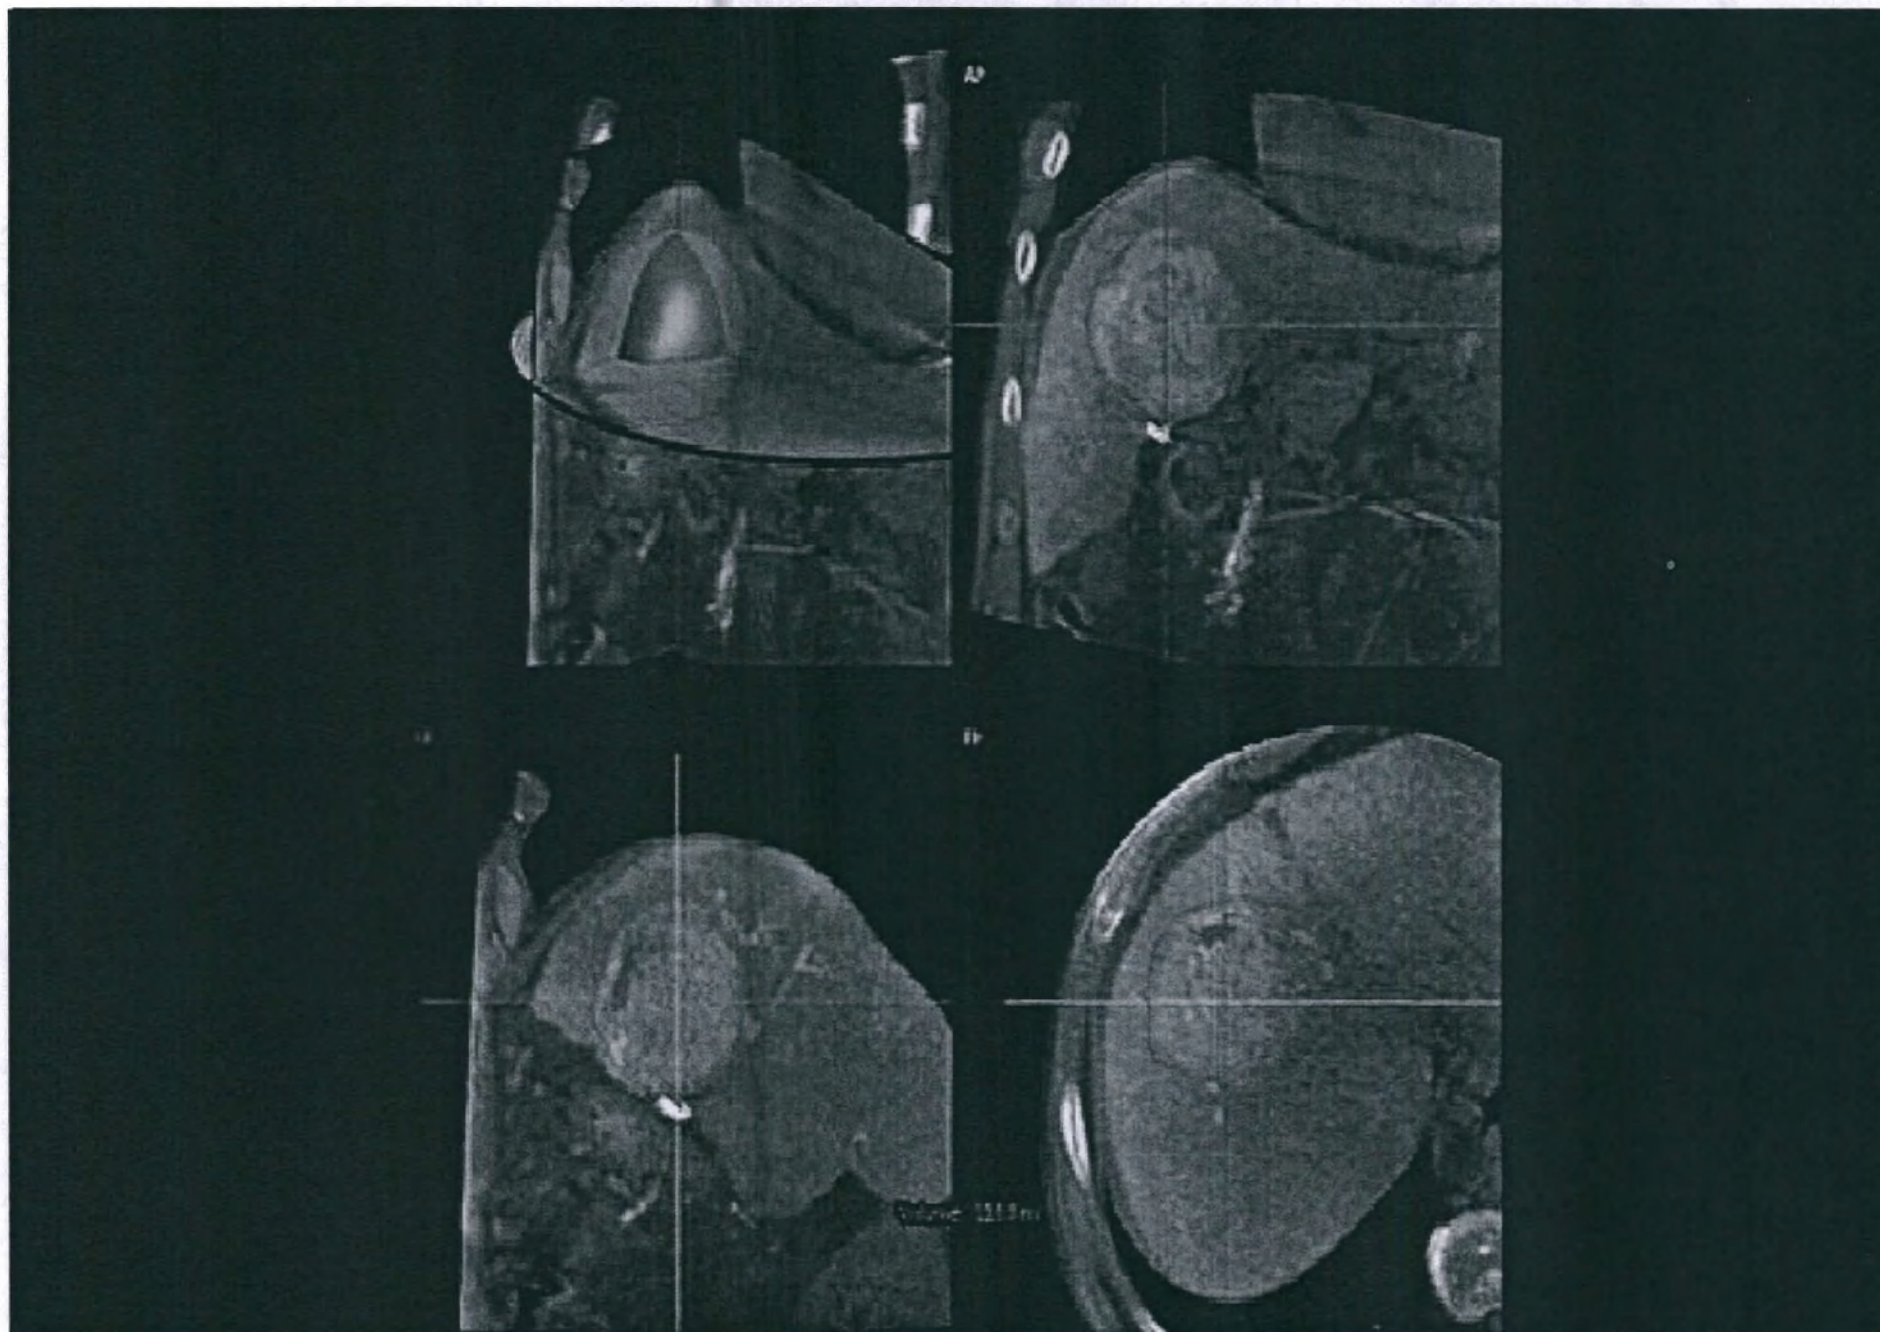

50.ч. Модули программные



50.ш. Модули программные


Abdomen XperCT

Rot: 90


Ang: 90

SliceThickness 20.76mm


SMA-PG

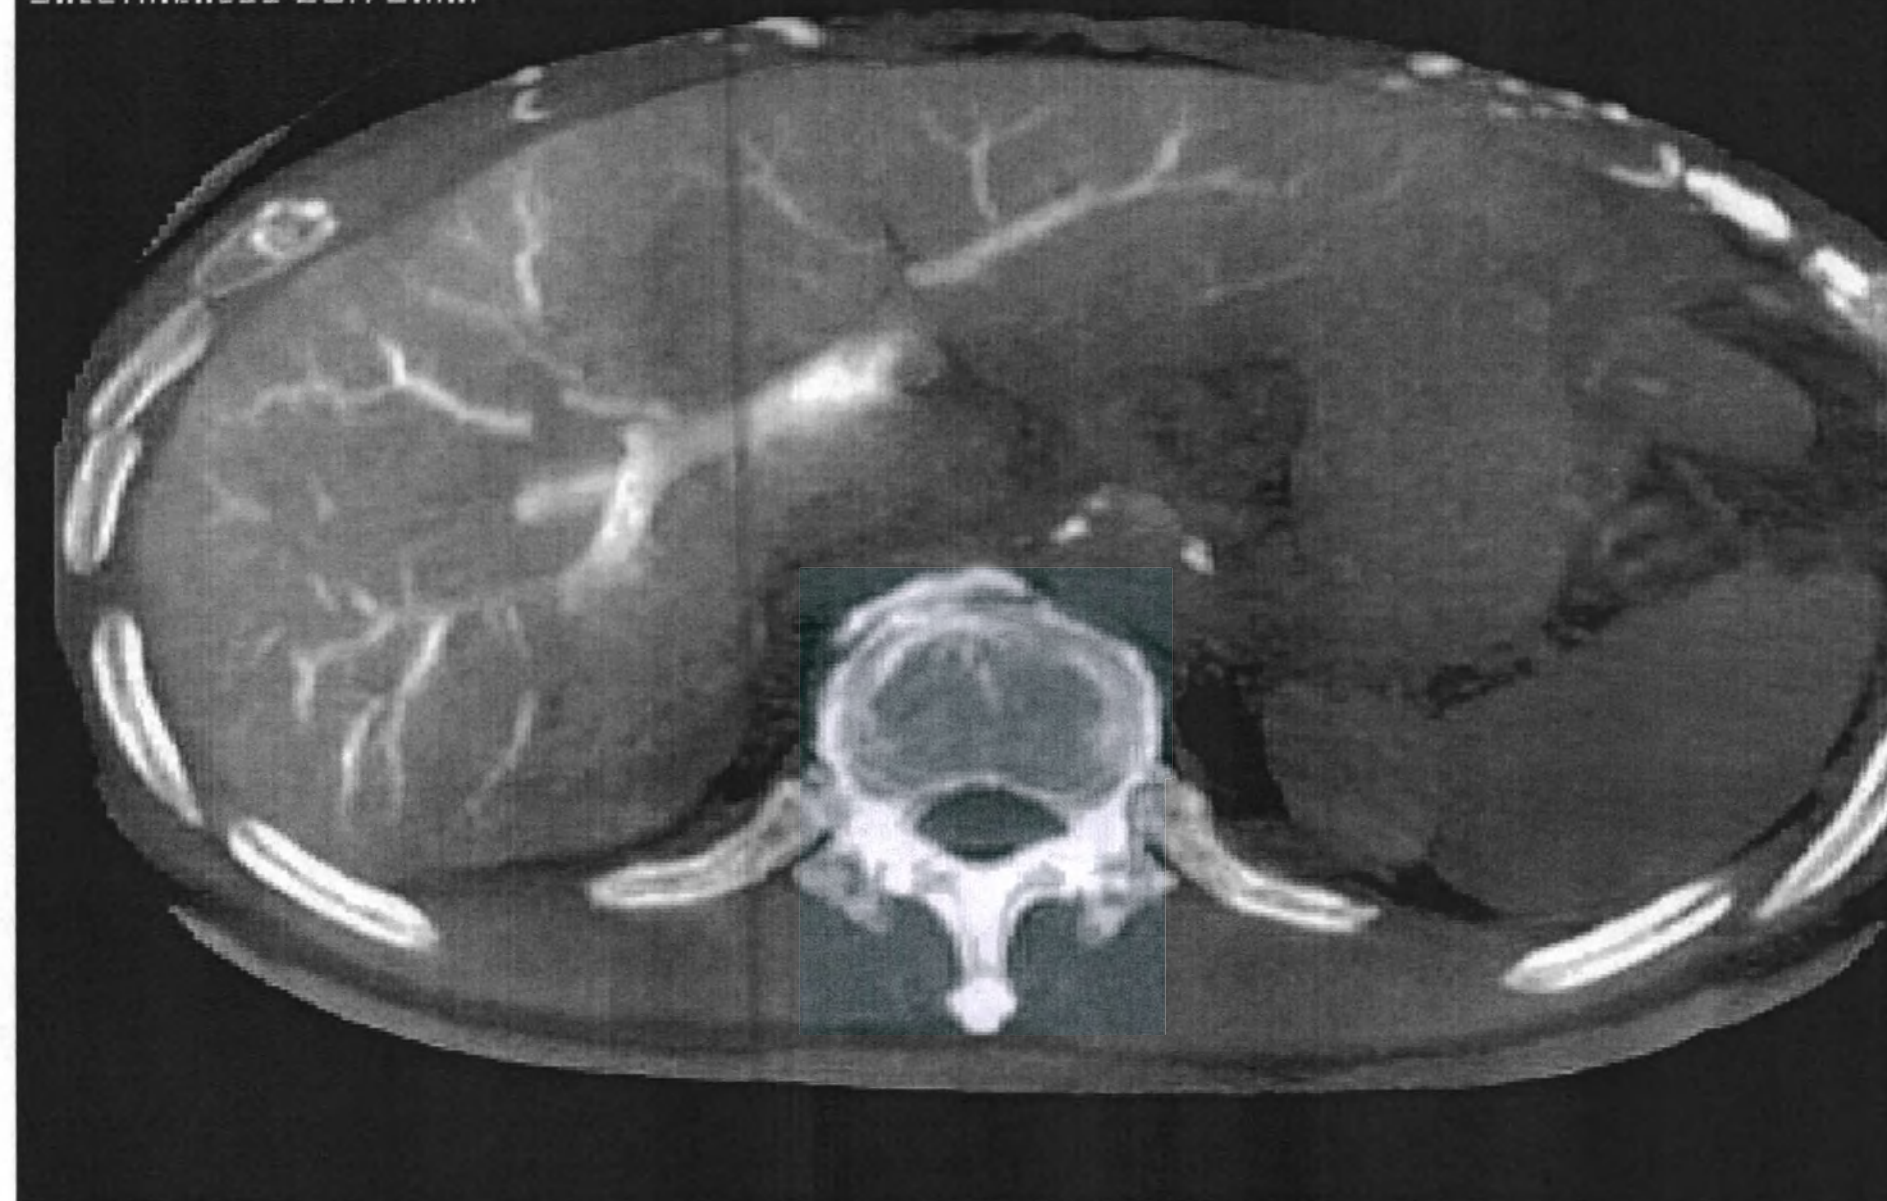


50.ш. Модули программные

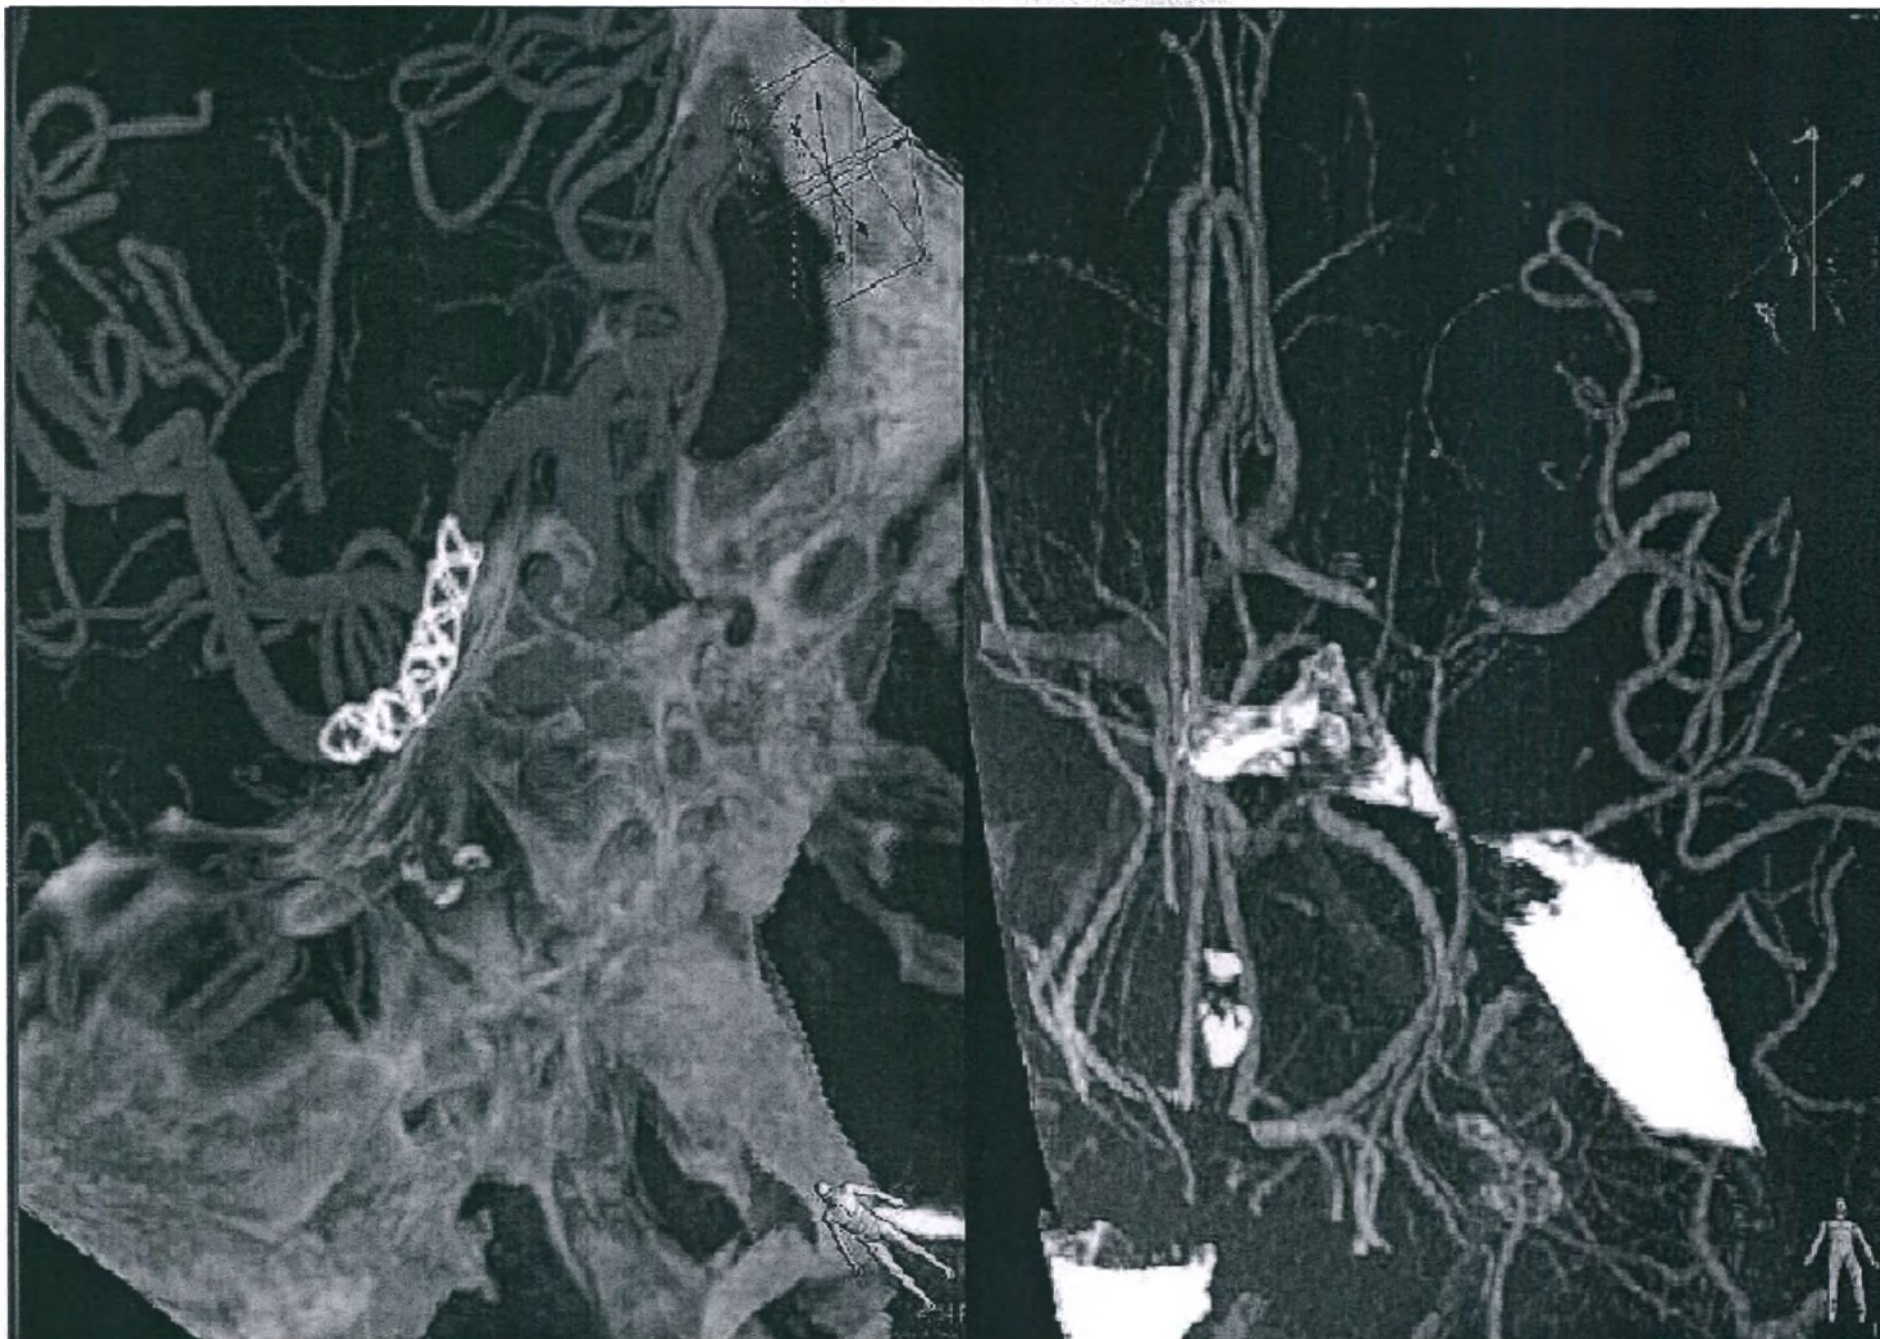


50.э. Модули программные

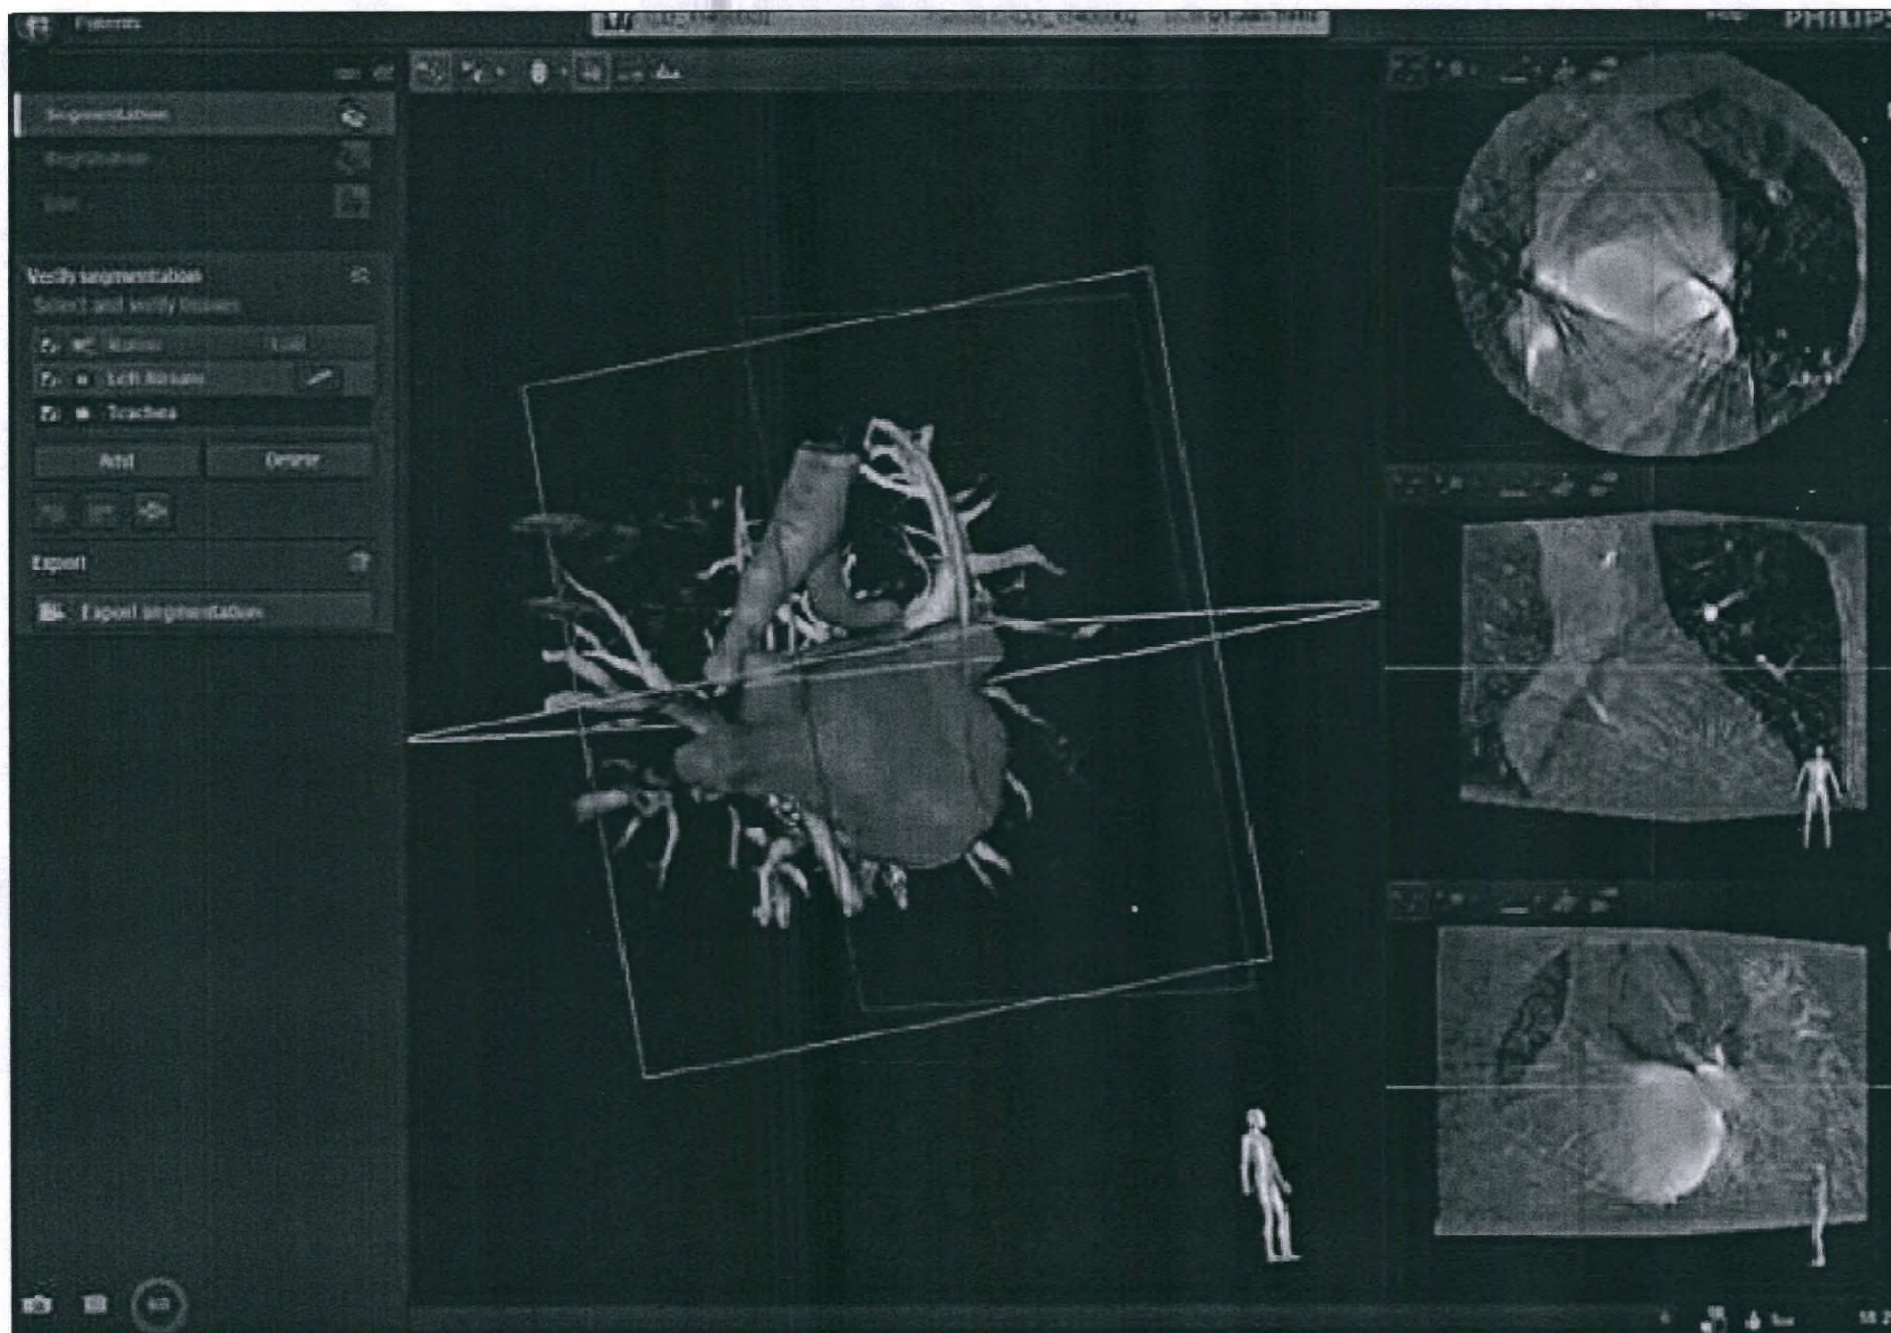


50.ю. Модули программные

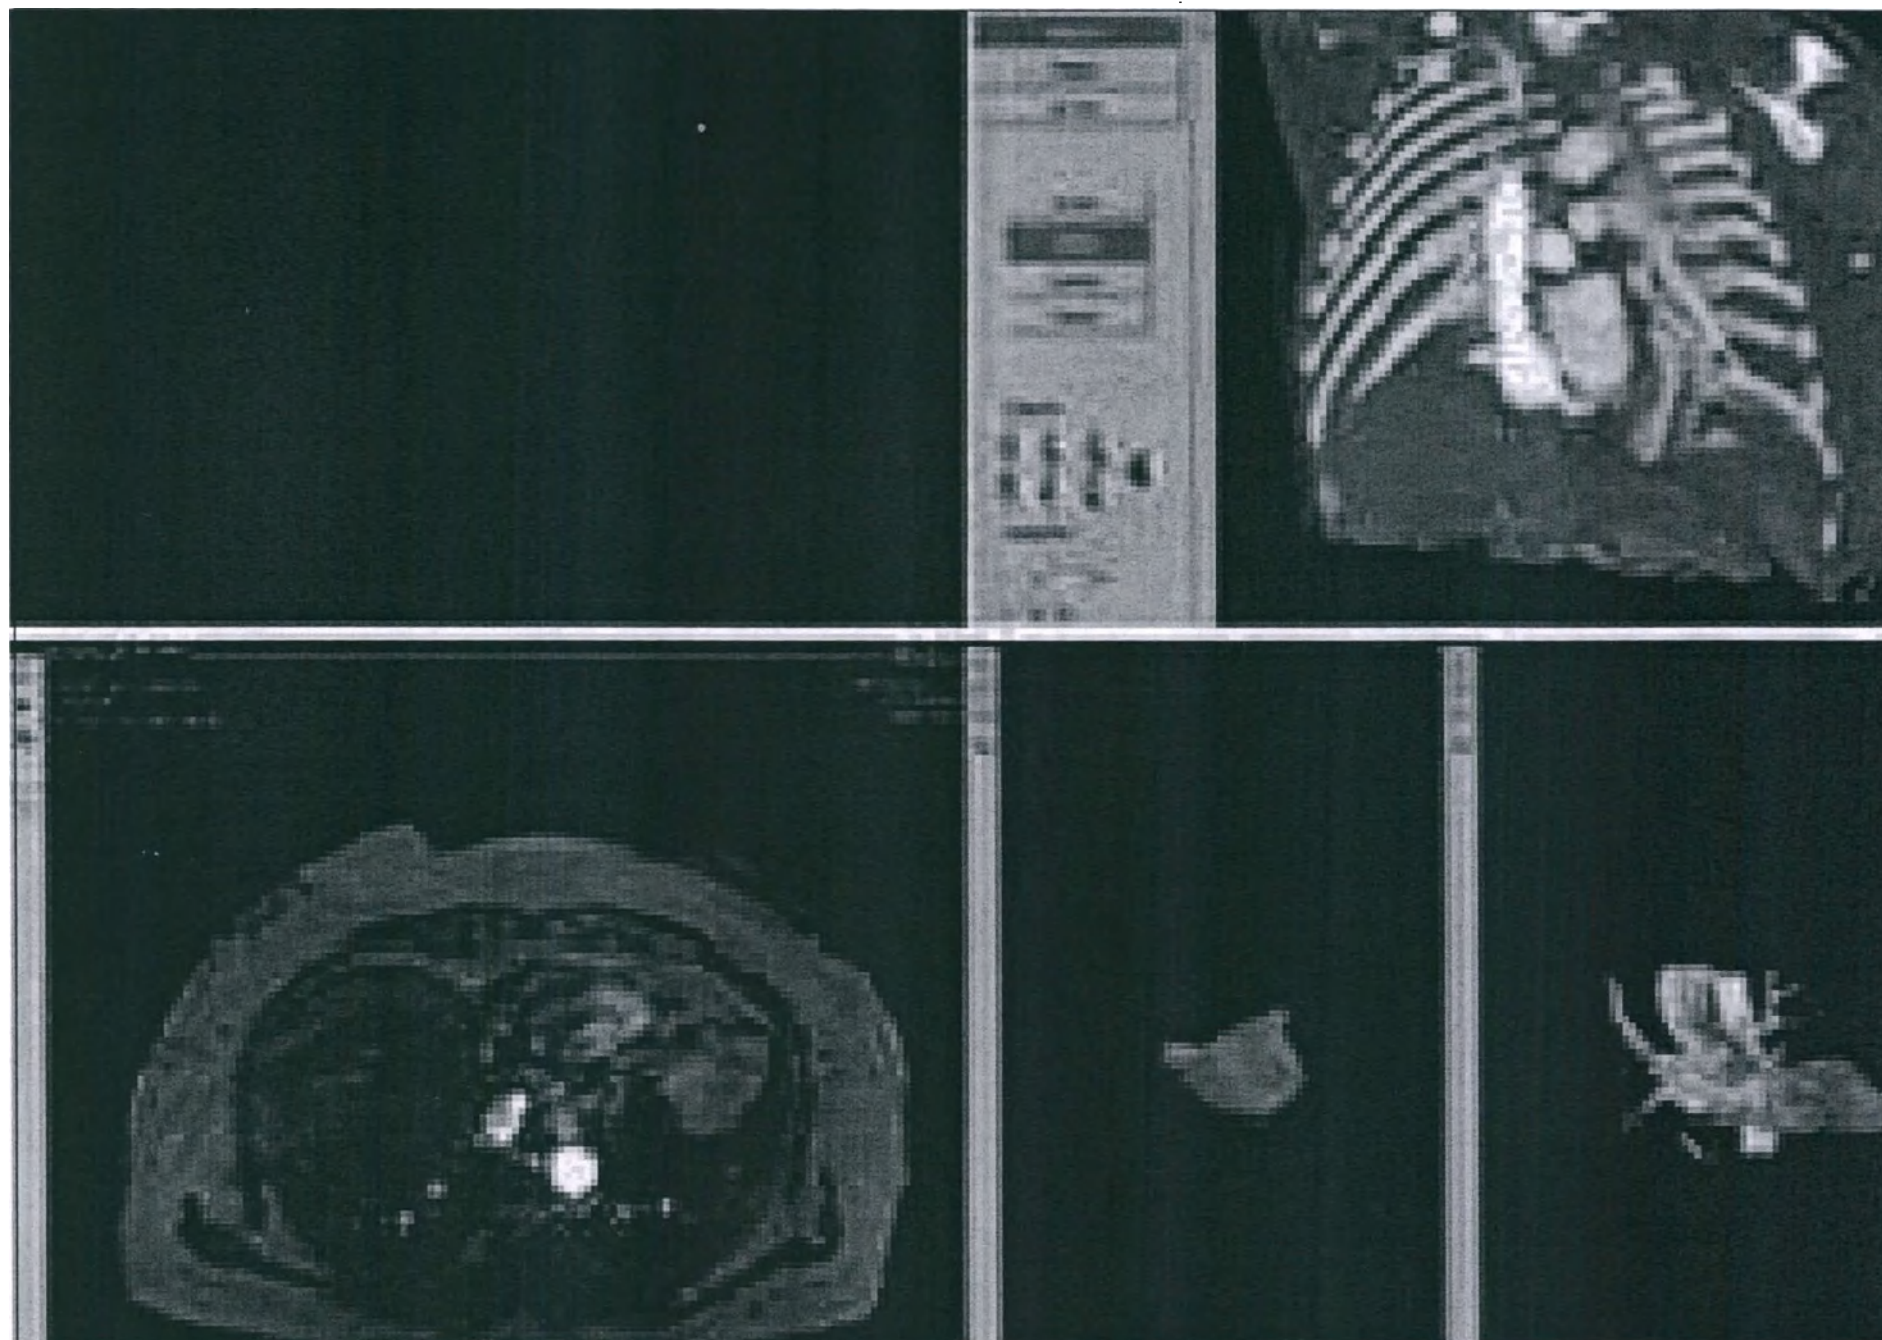


50.я. Модули программные

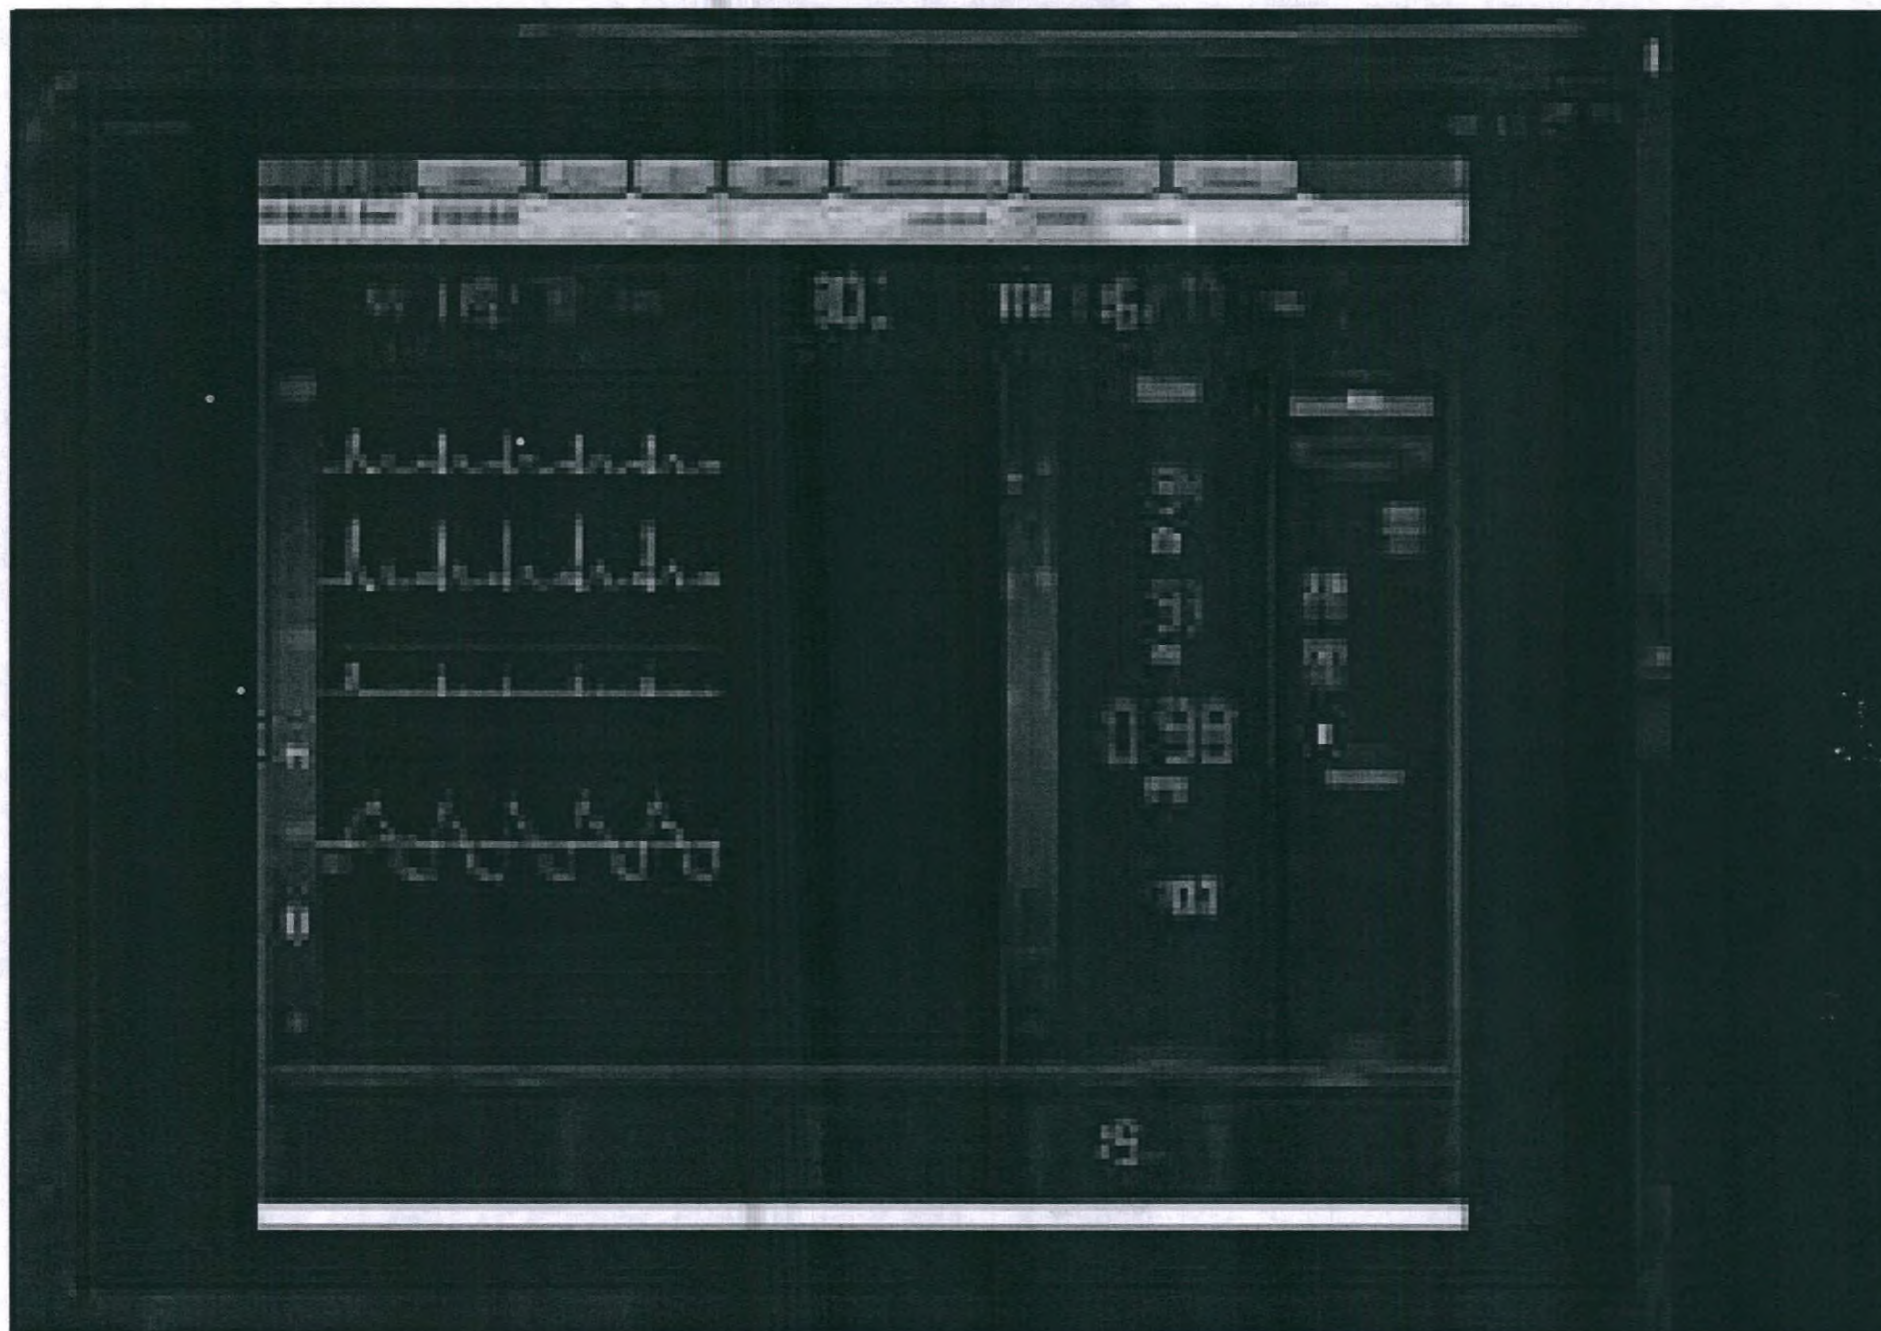

50.aa. Модули программные

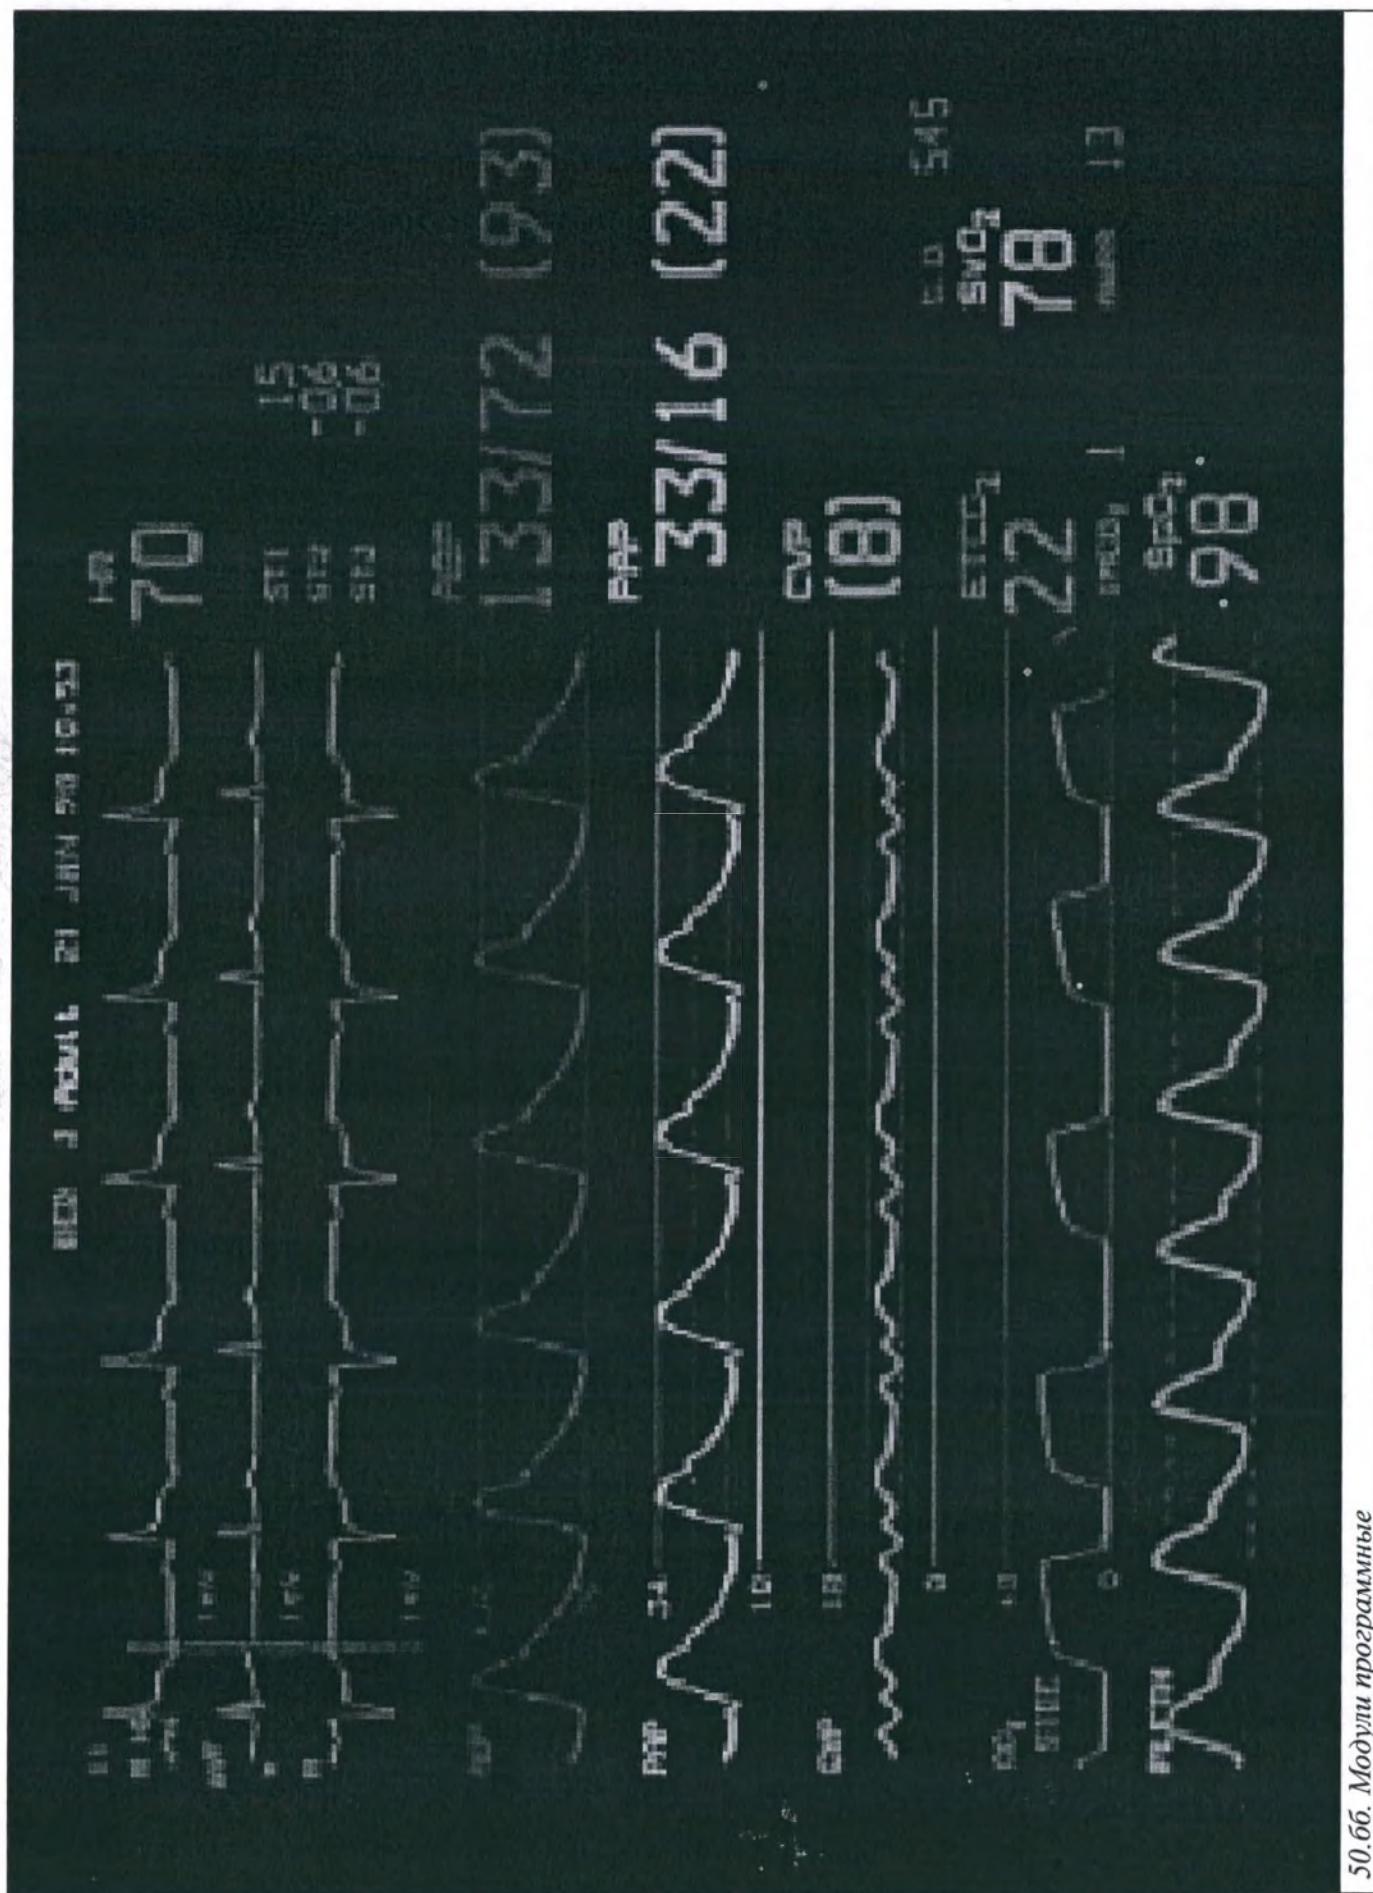

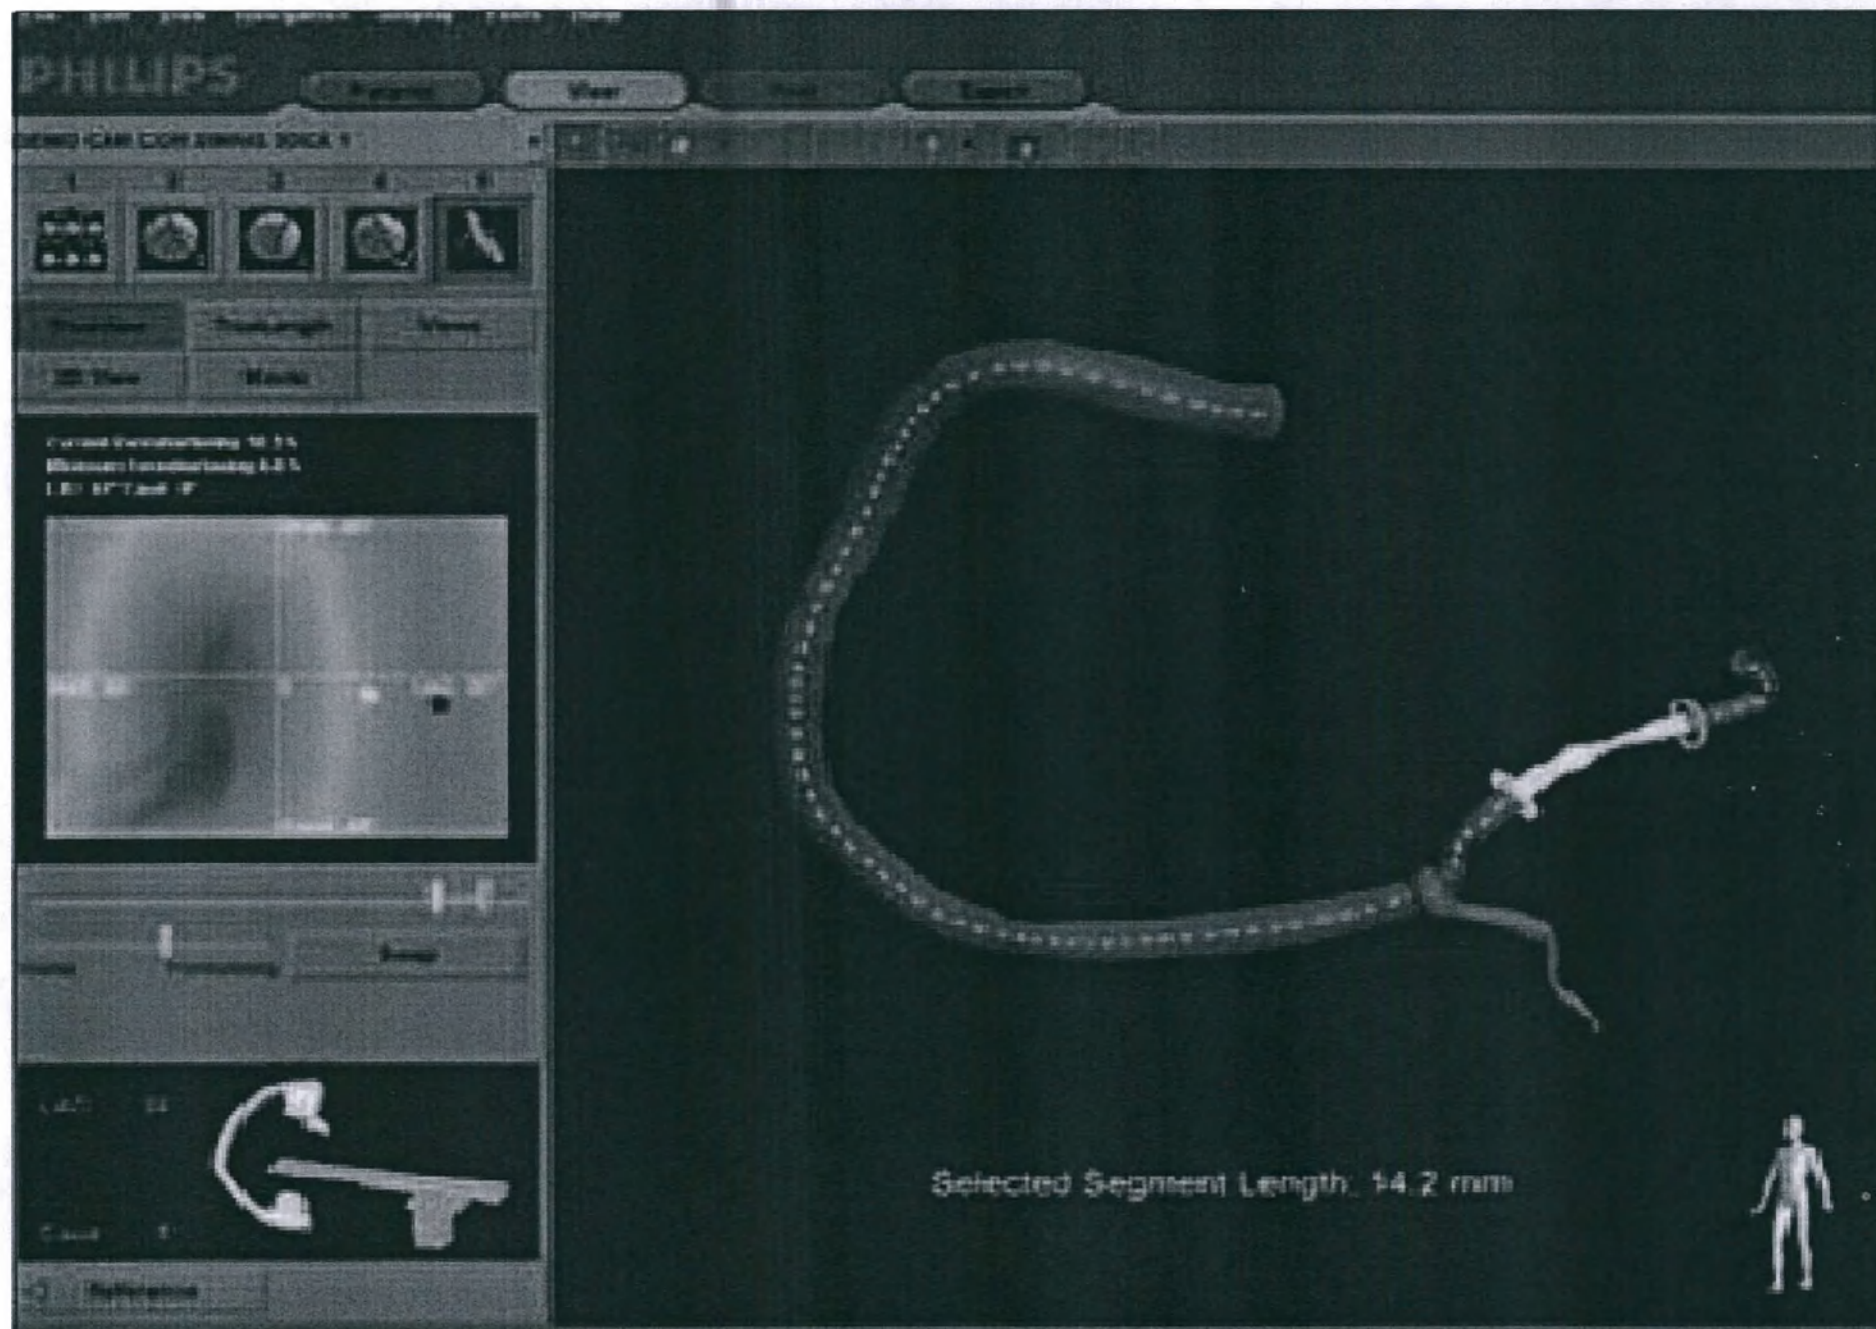


50.вв. Модули программные



50.22. Модули программные



50.дд. Модули программные

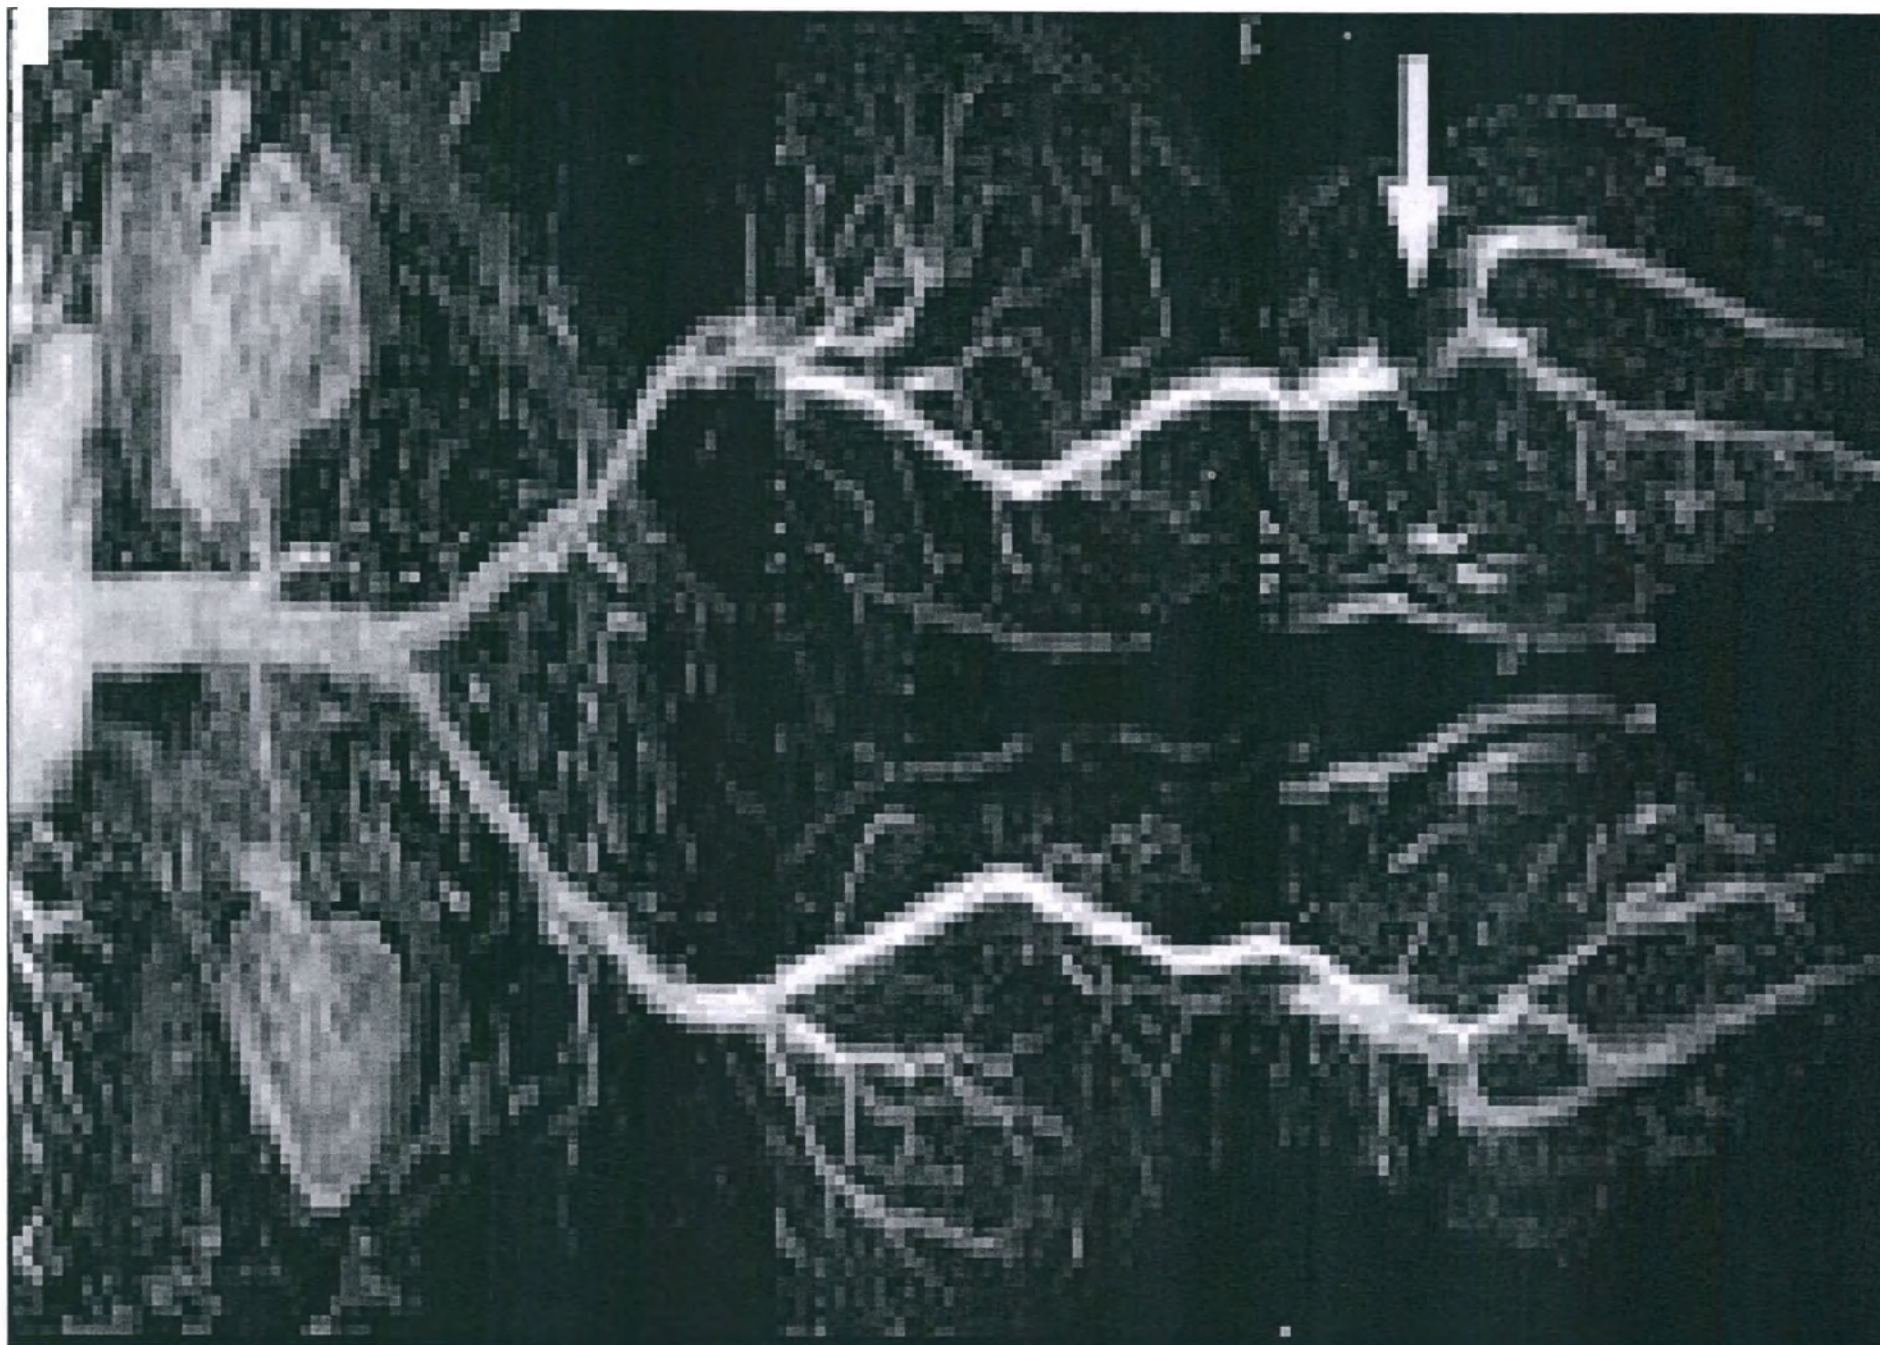


50.е. Модули программные




50.жж. Модули программные




Frontal Unzoom live fluoro
on reference monitor

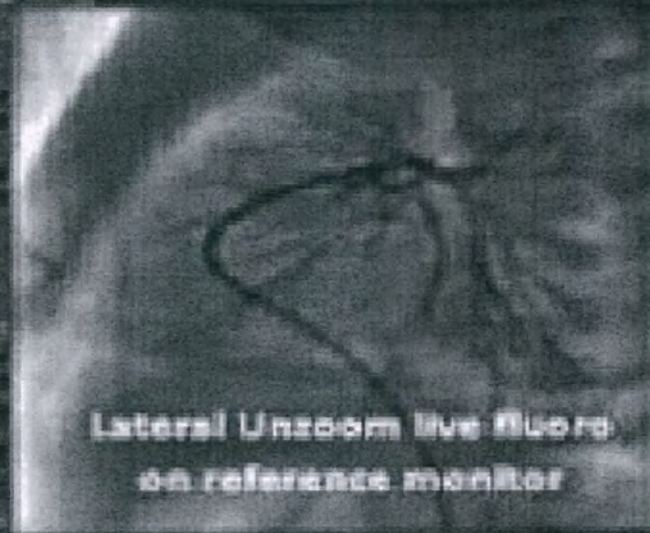


Lateral Unzoom live fluoro
on reference monitor

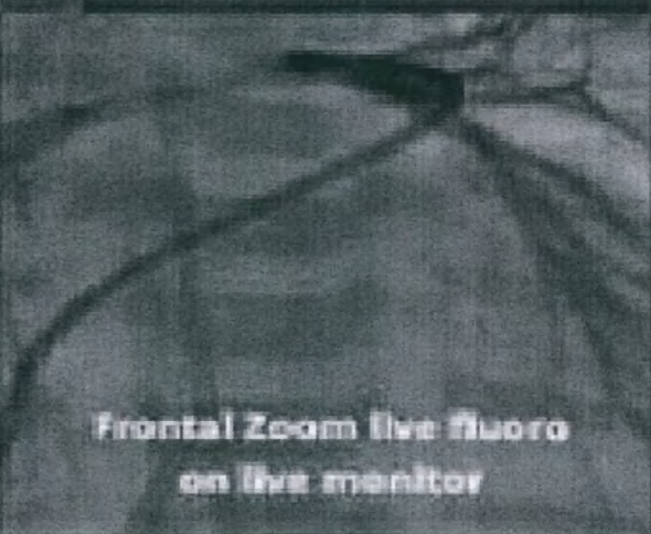


Frontal Zoom live fluoro
on live monitor

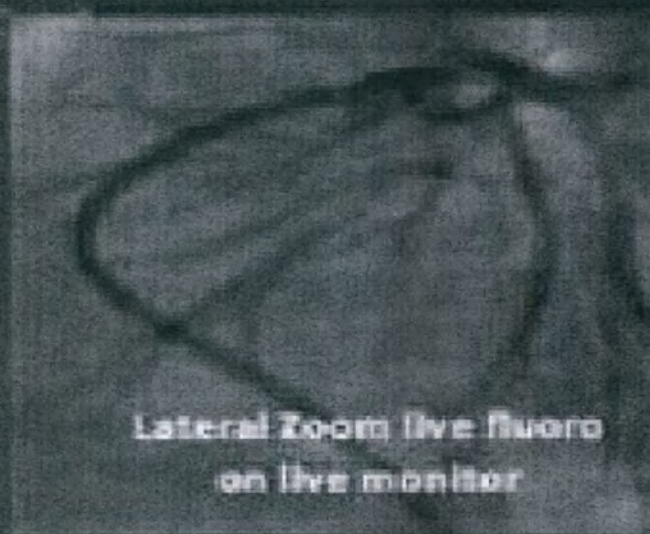


Lateral Zoom live fluoro
on live monitor

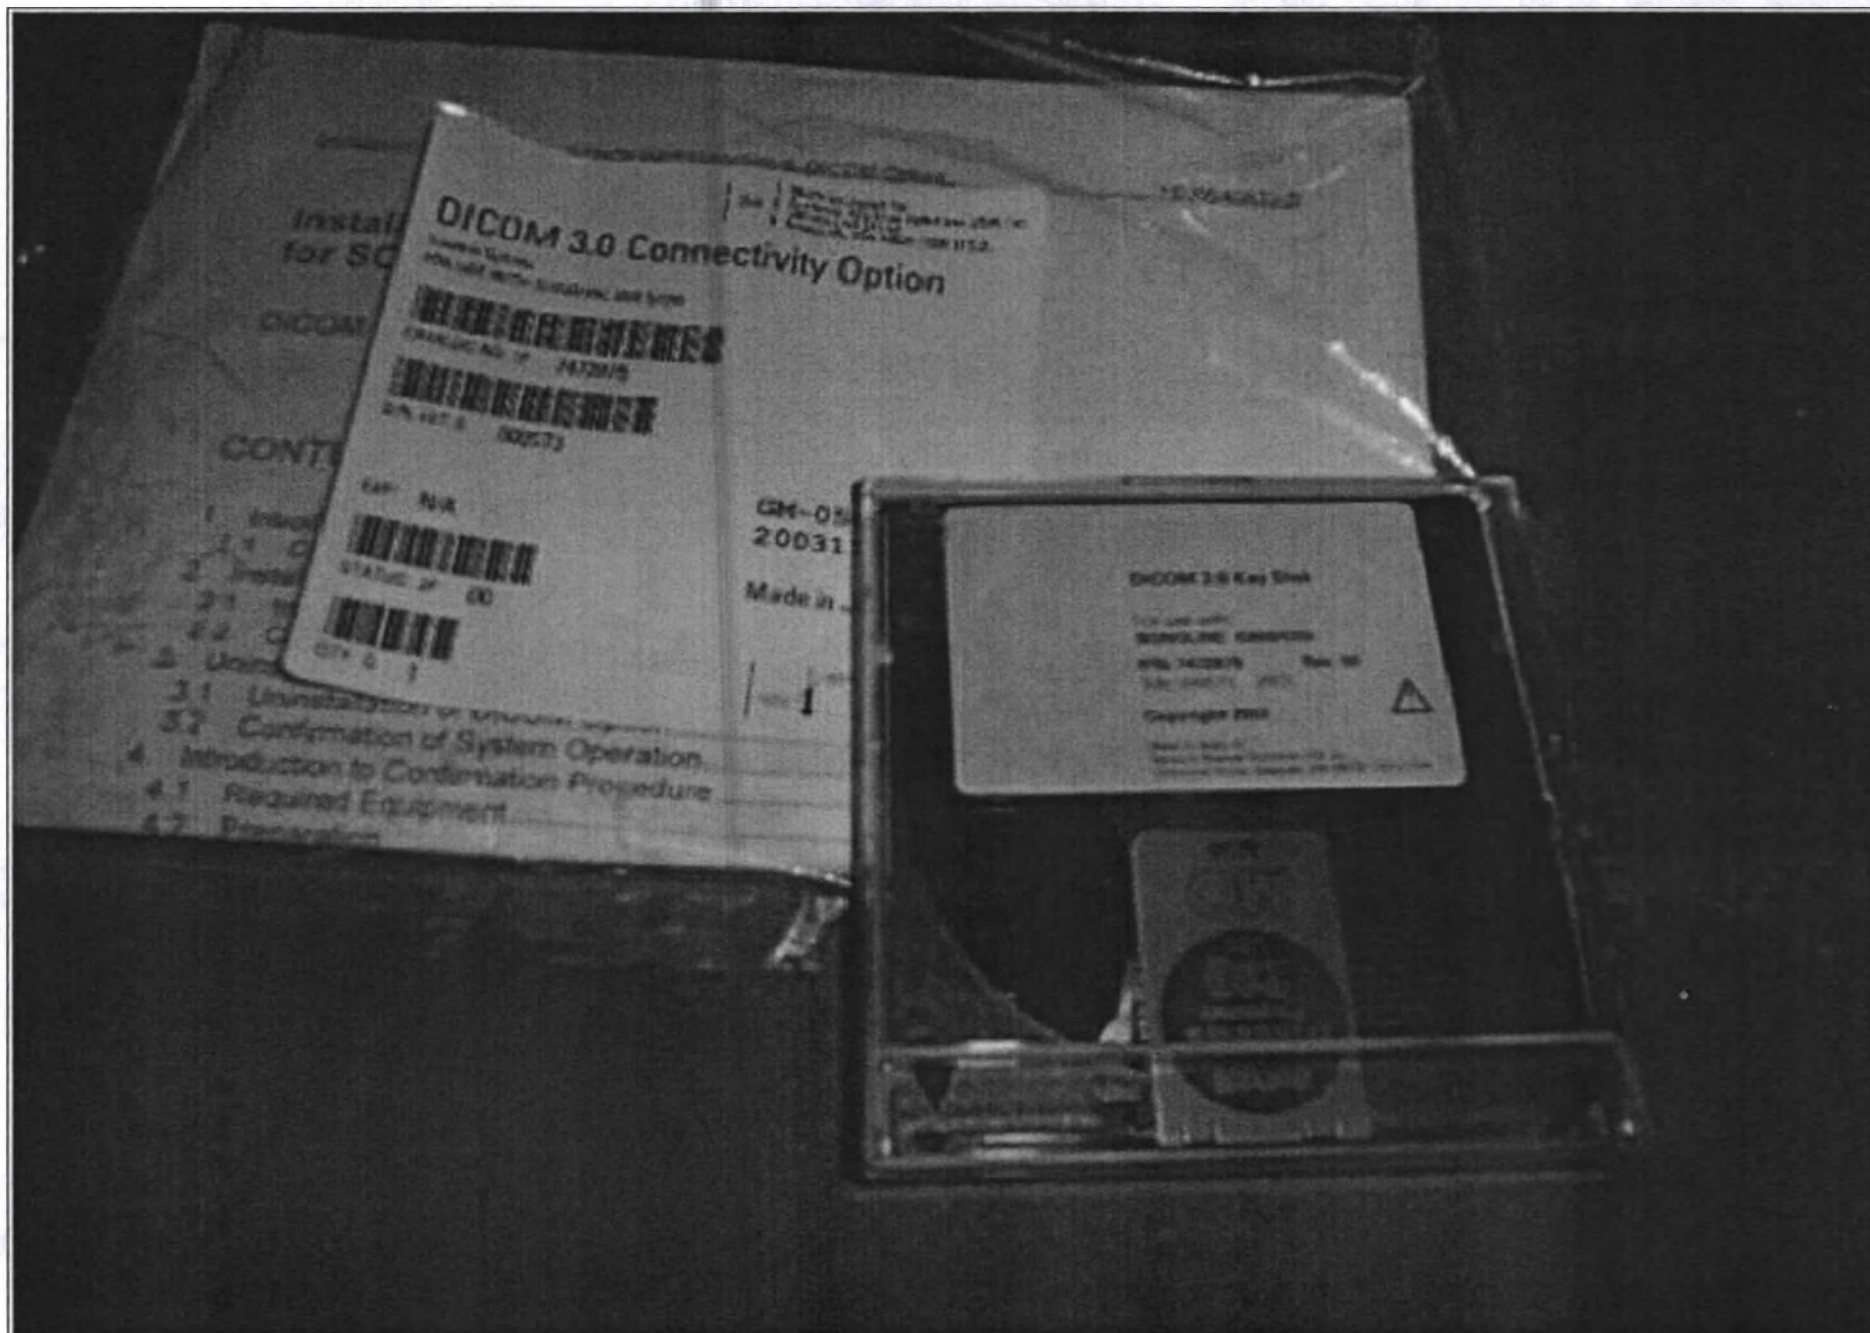


51. Лицензионные ключи DICOM

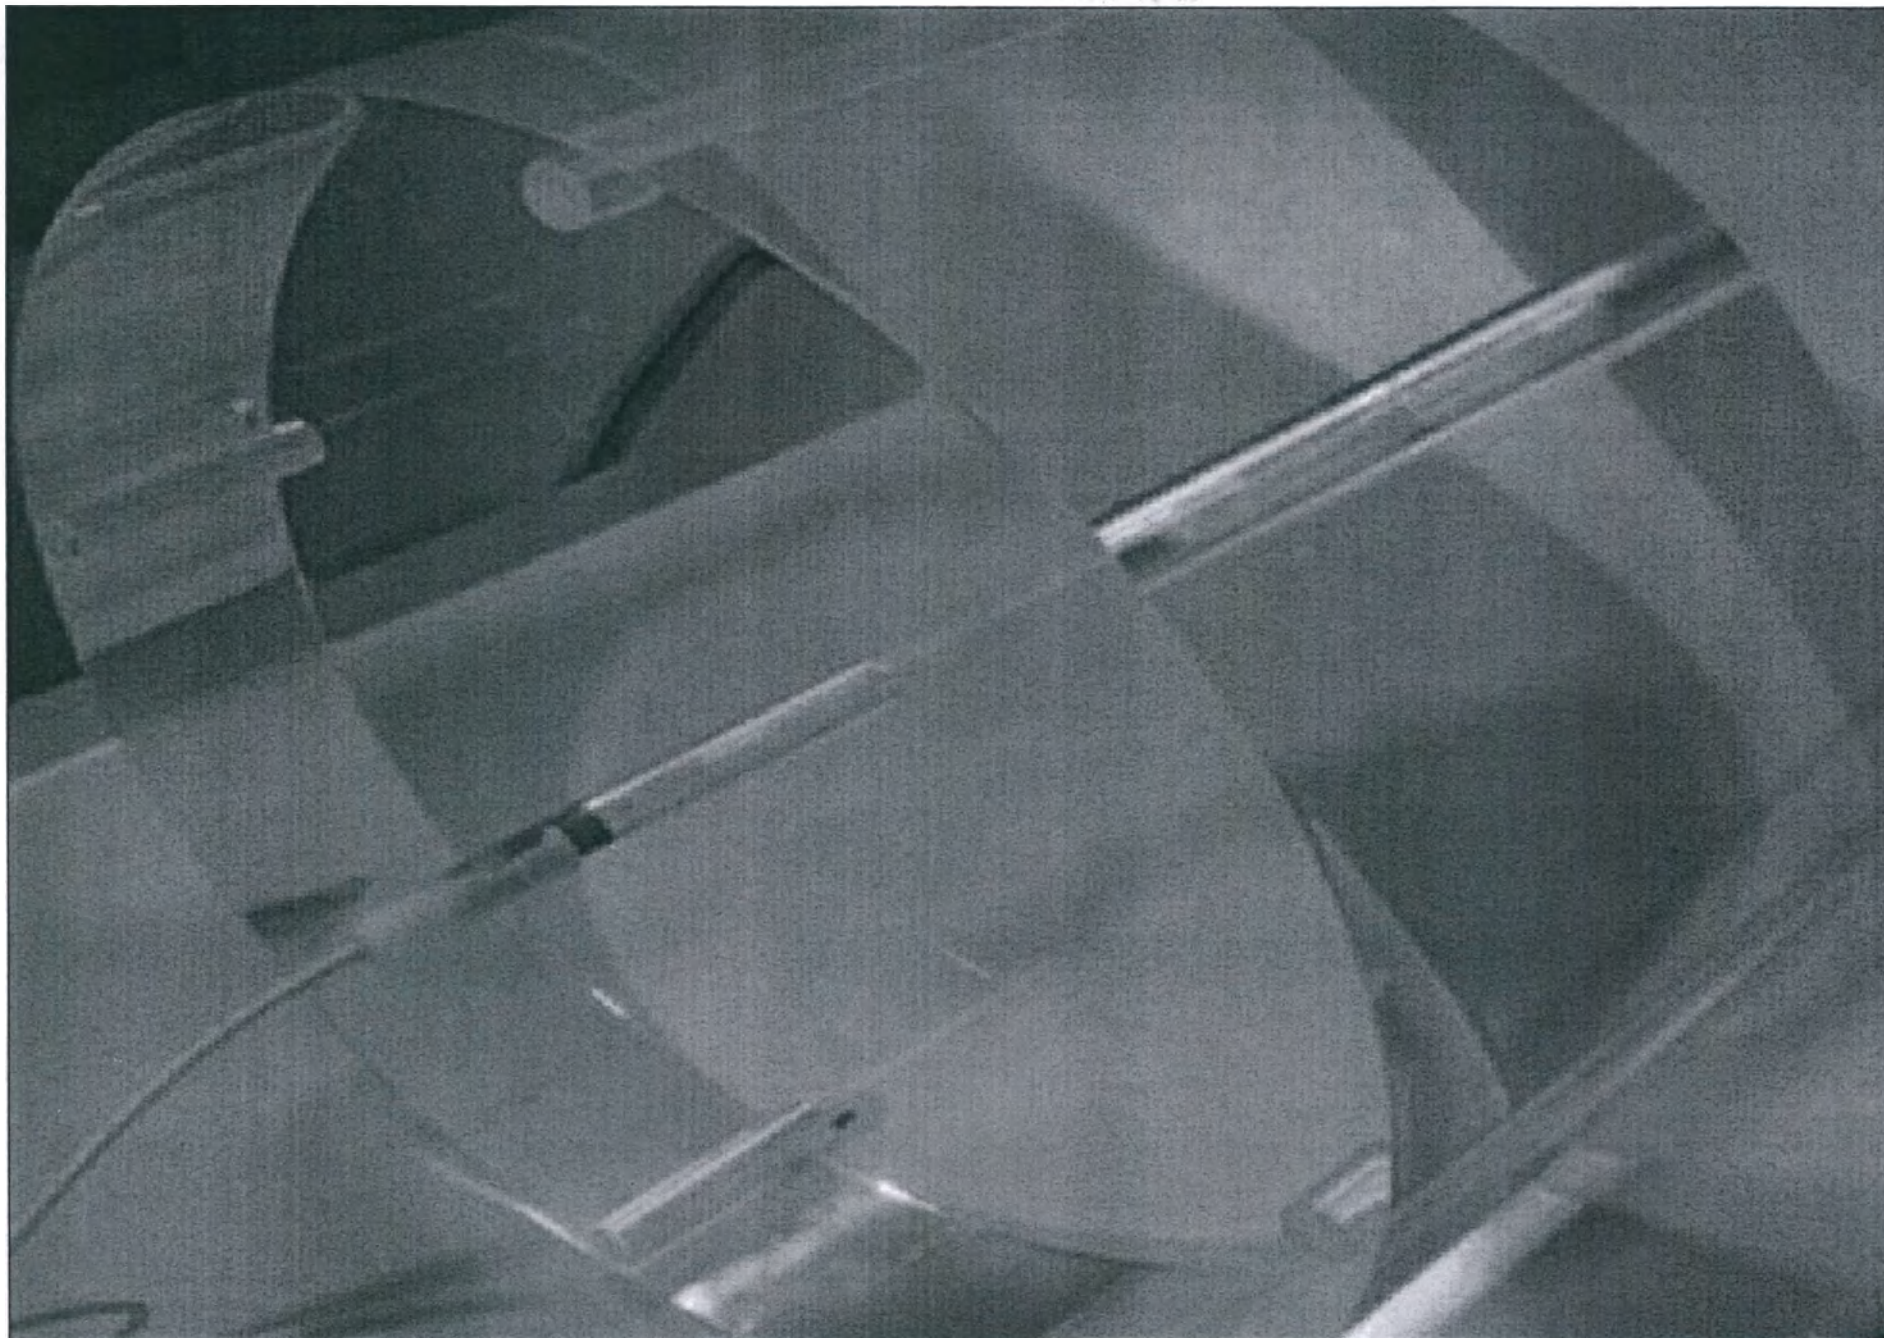


52. Фантом калибровочный для получения 3D-изображений.

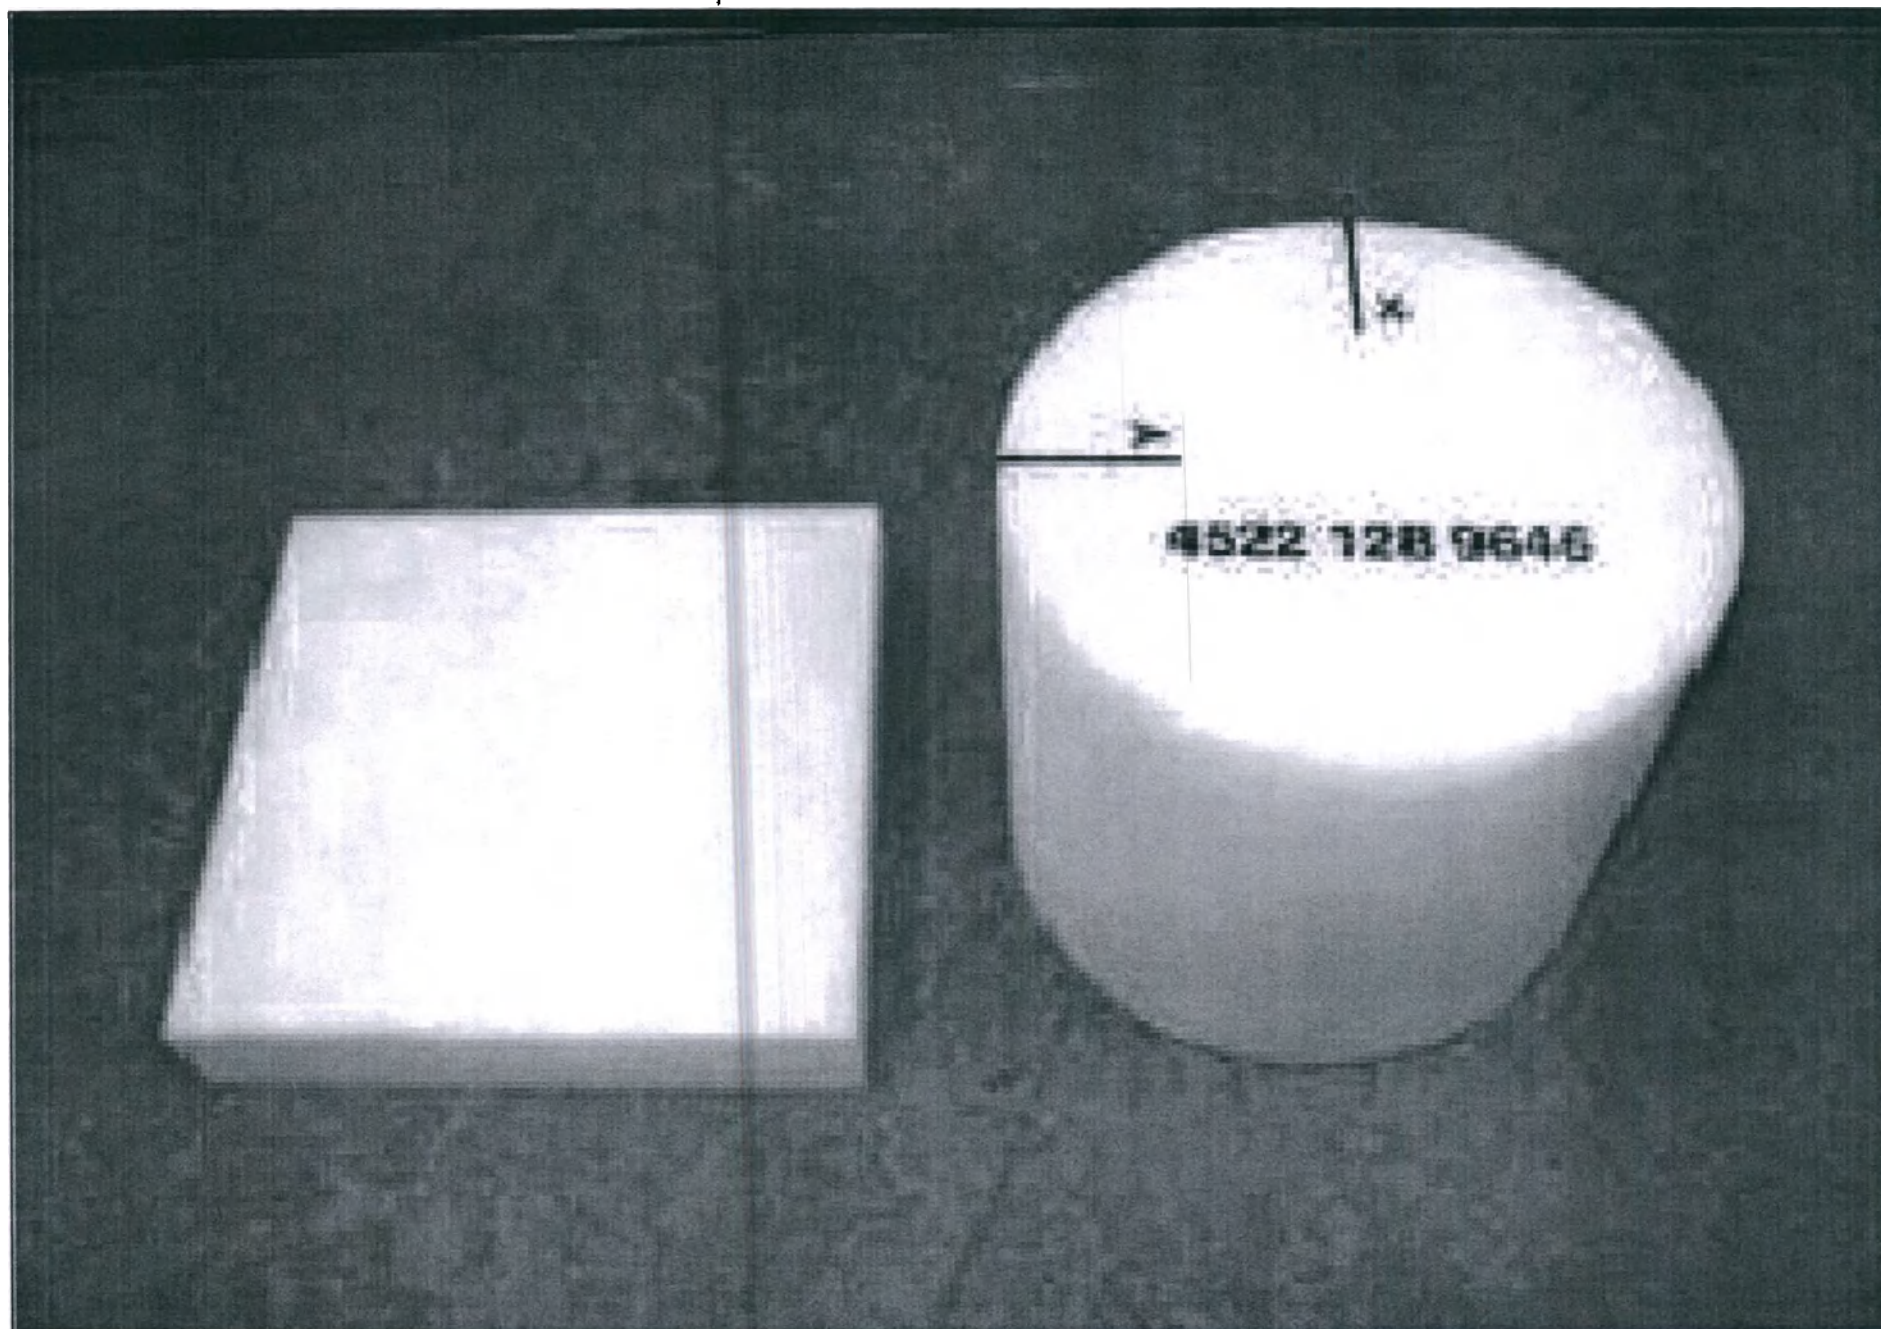


53. Фантом калибровочный для области головы.

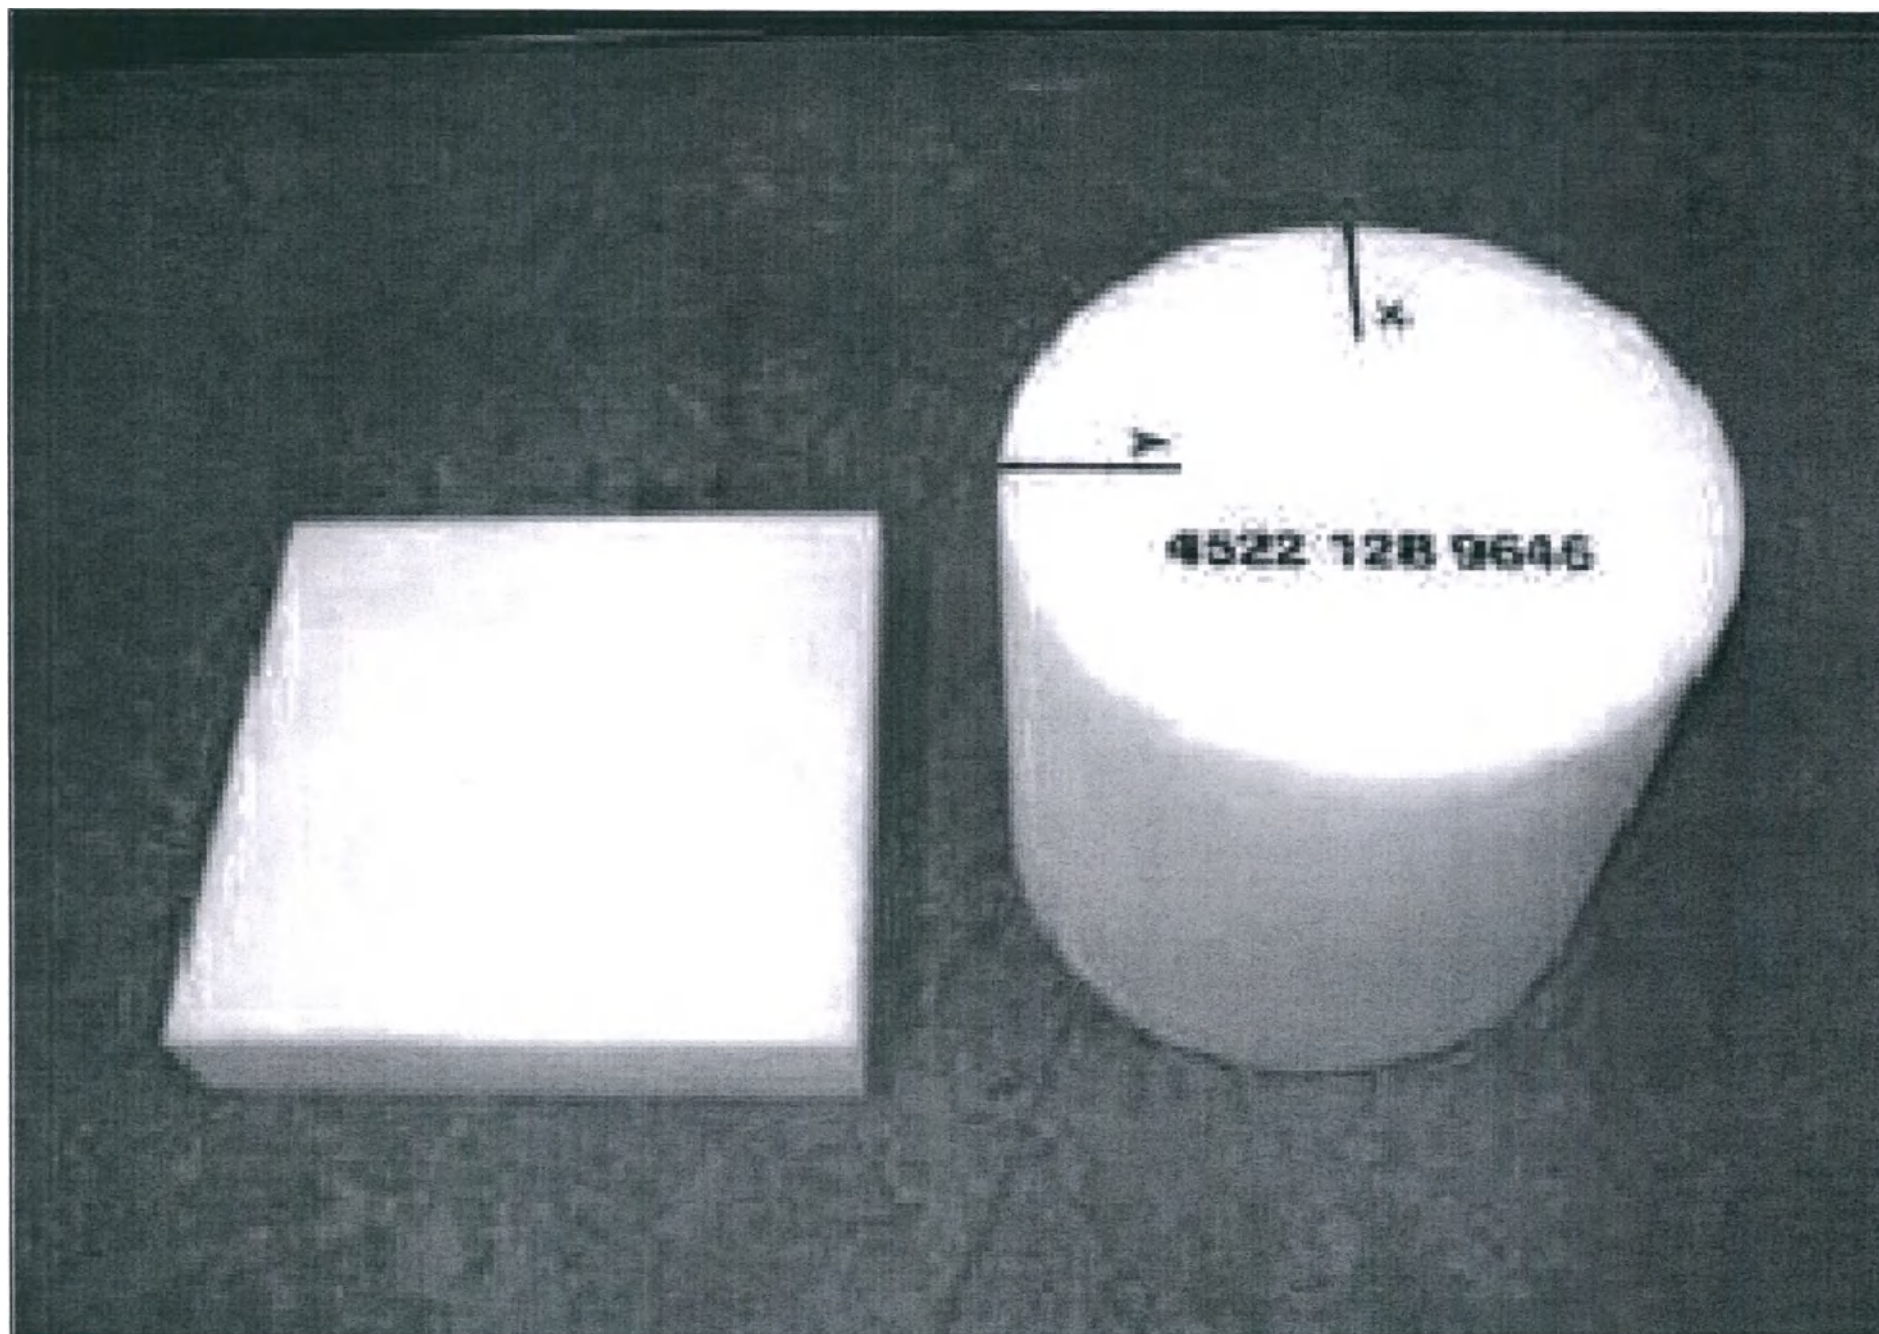

54. Фантом калибровочный для тела.

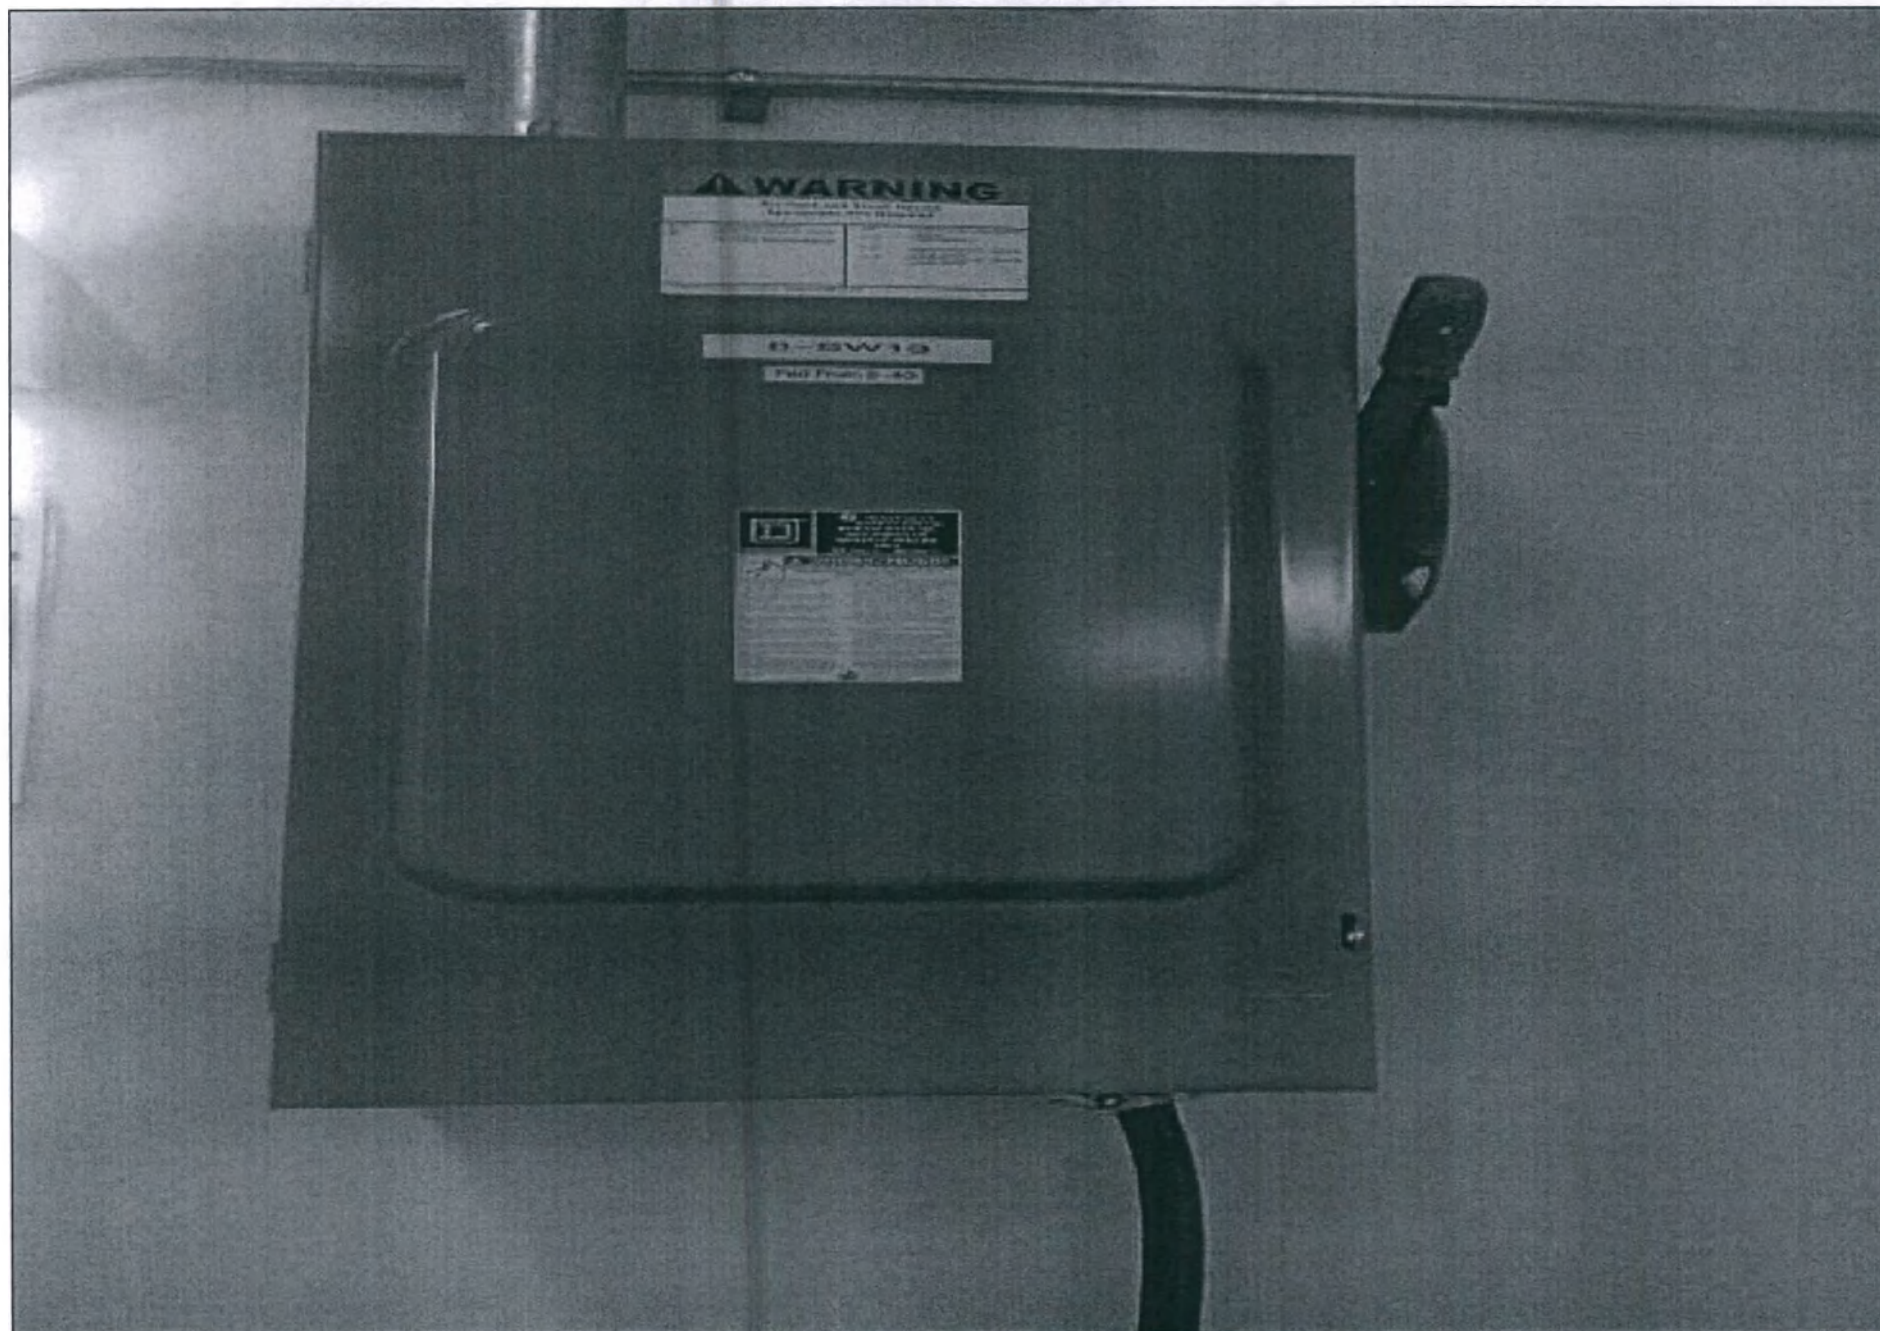



55. Выключатель электрический

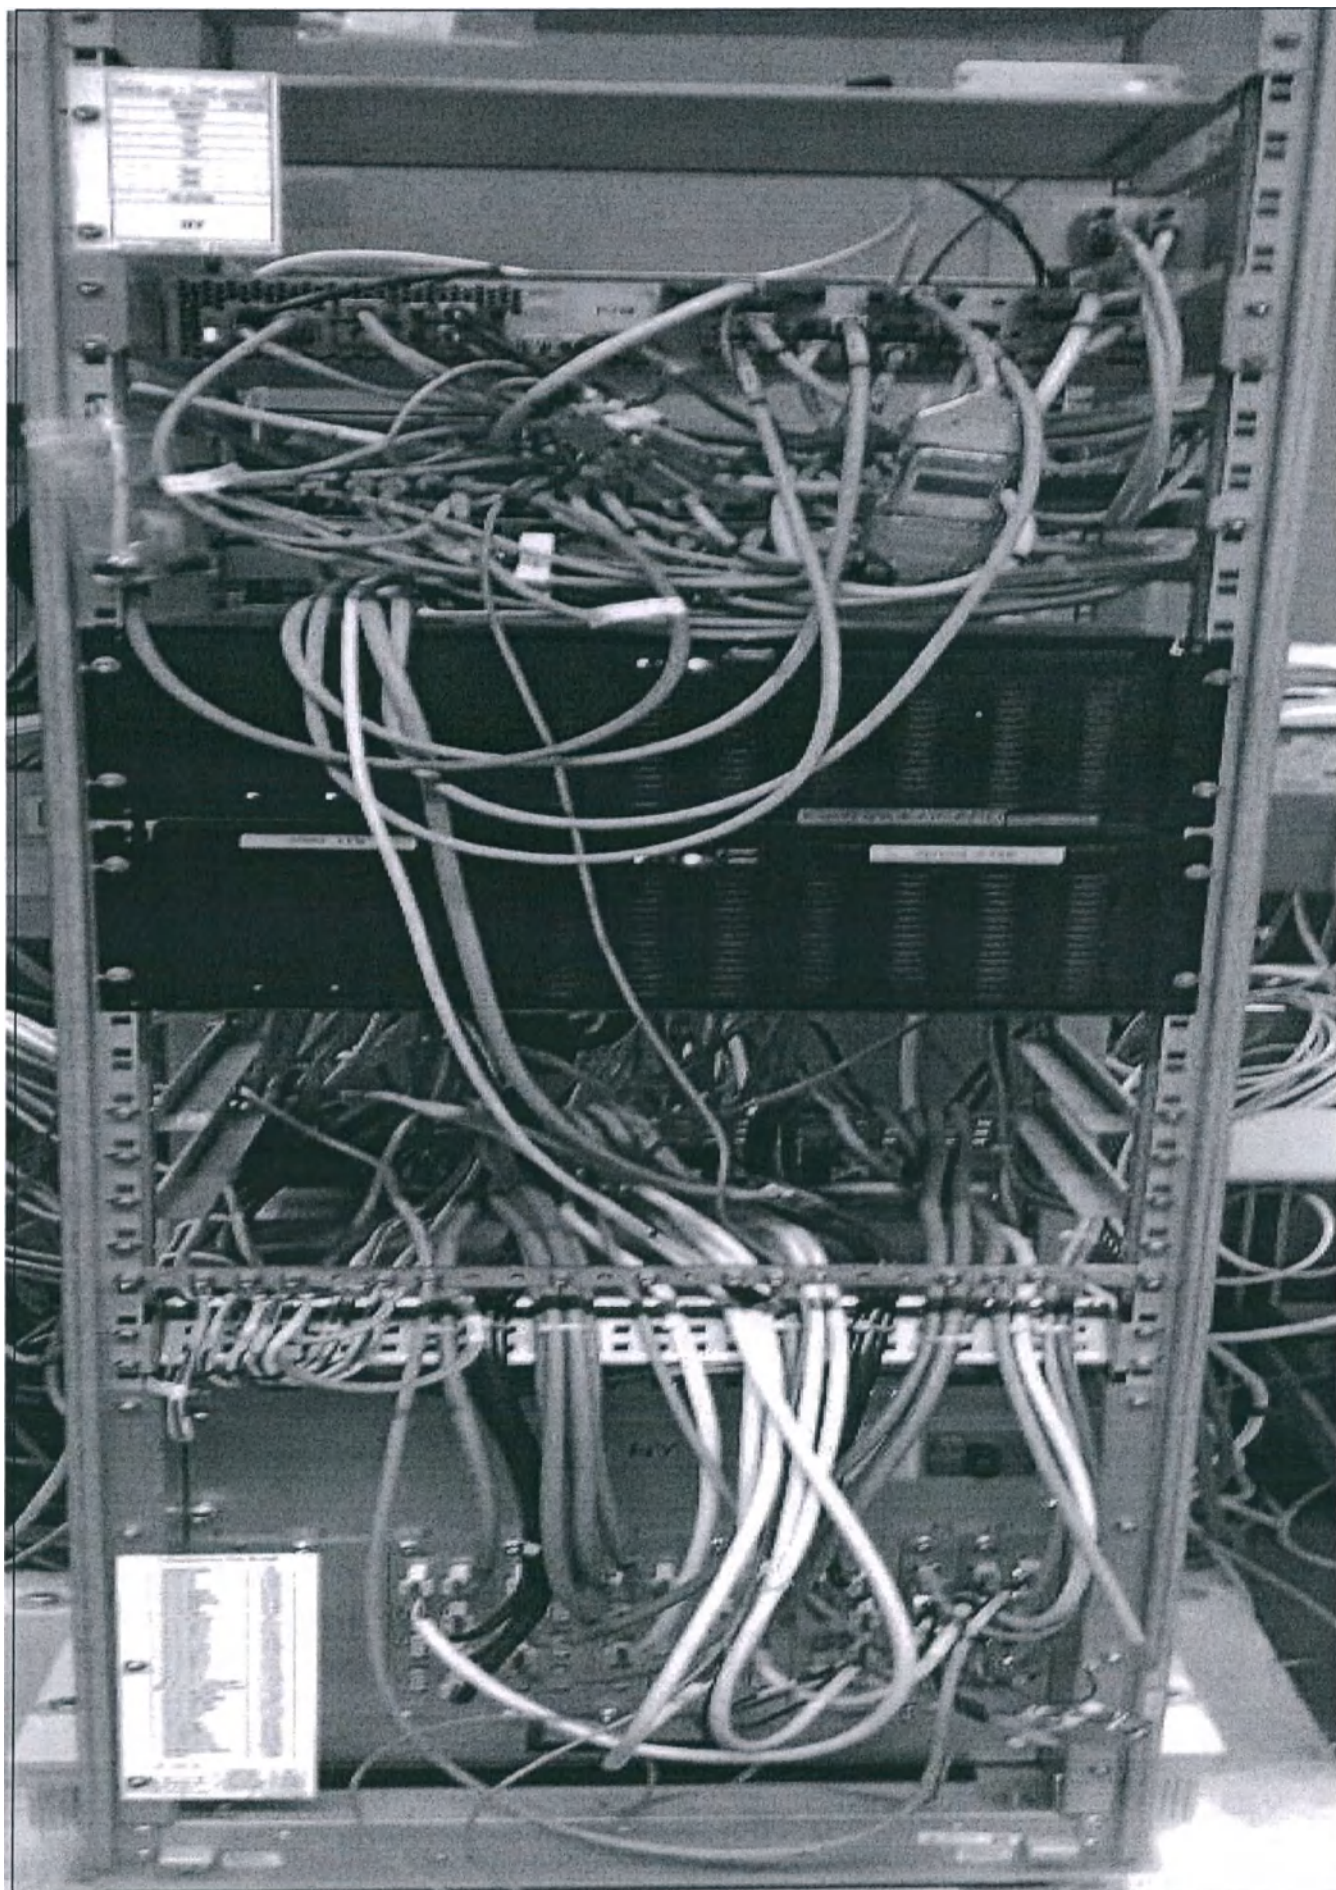

56.а. Распределительный шкаф для дополнительного оборудования


56.6. Распределительный шкаф для дополнительного оборудования

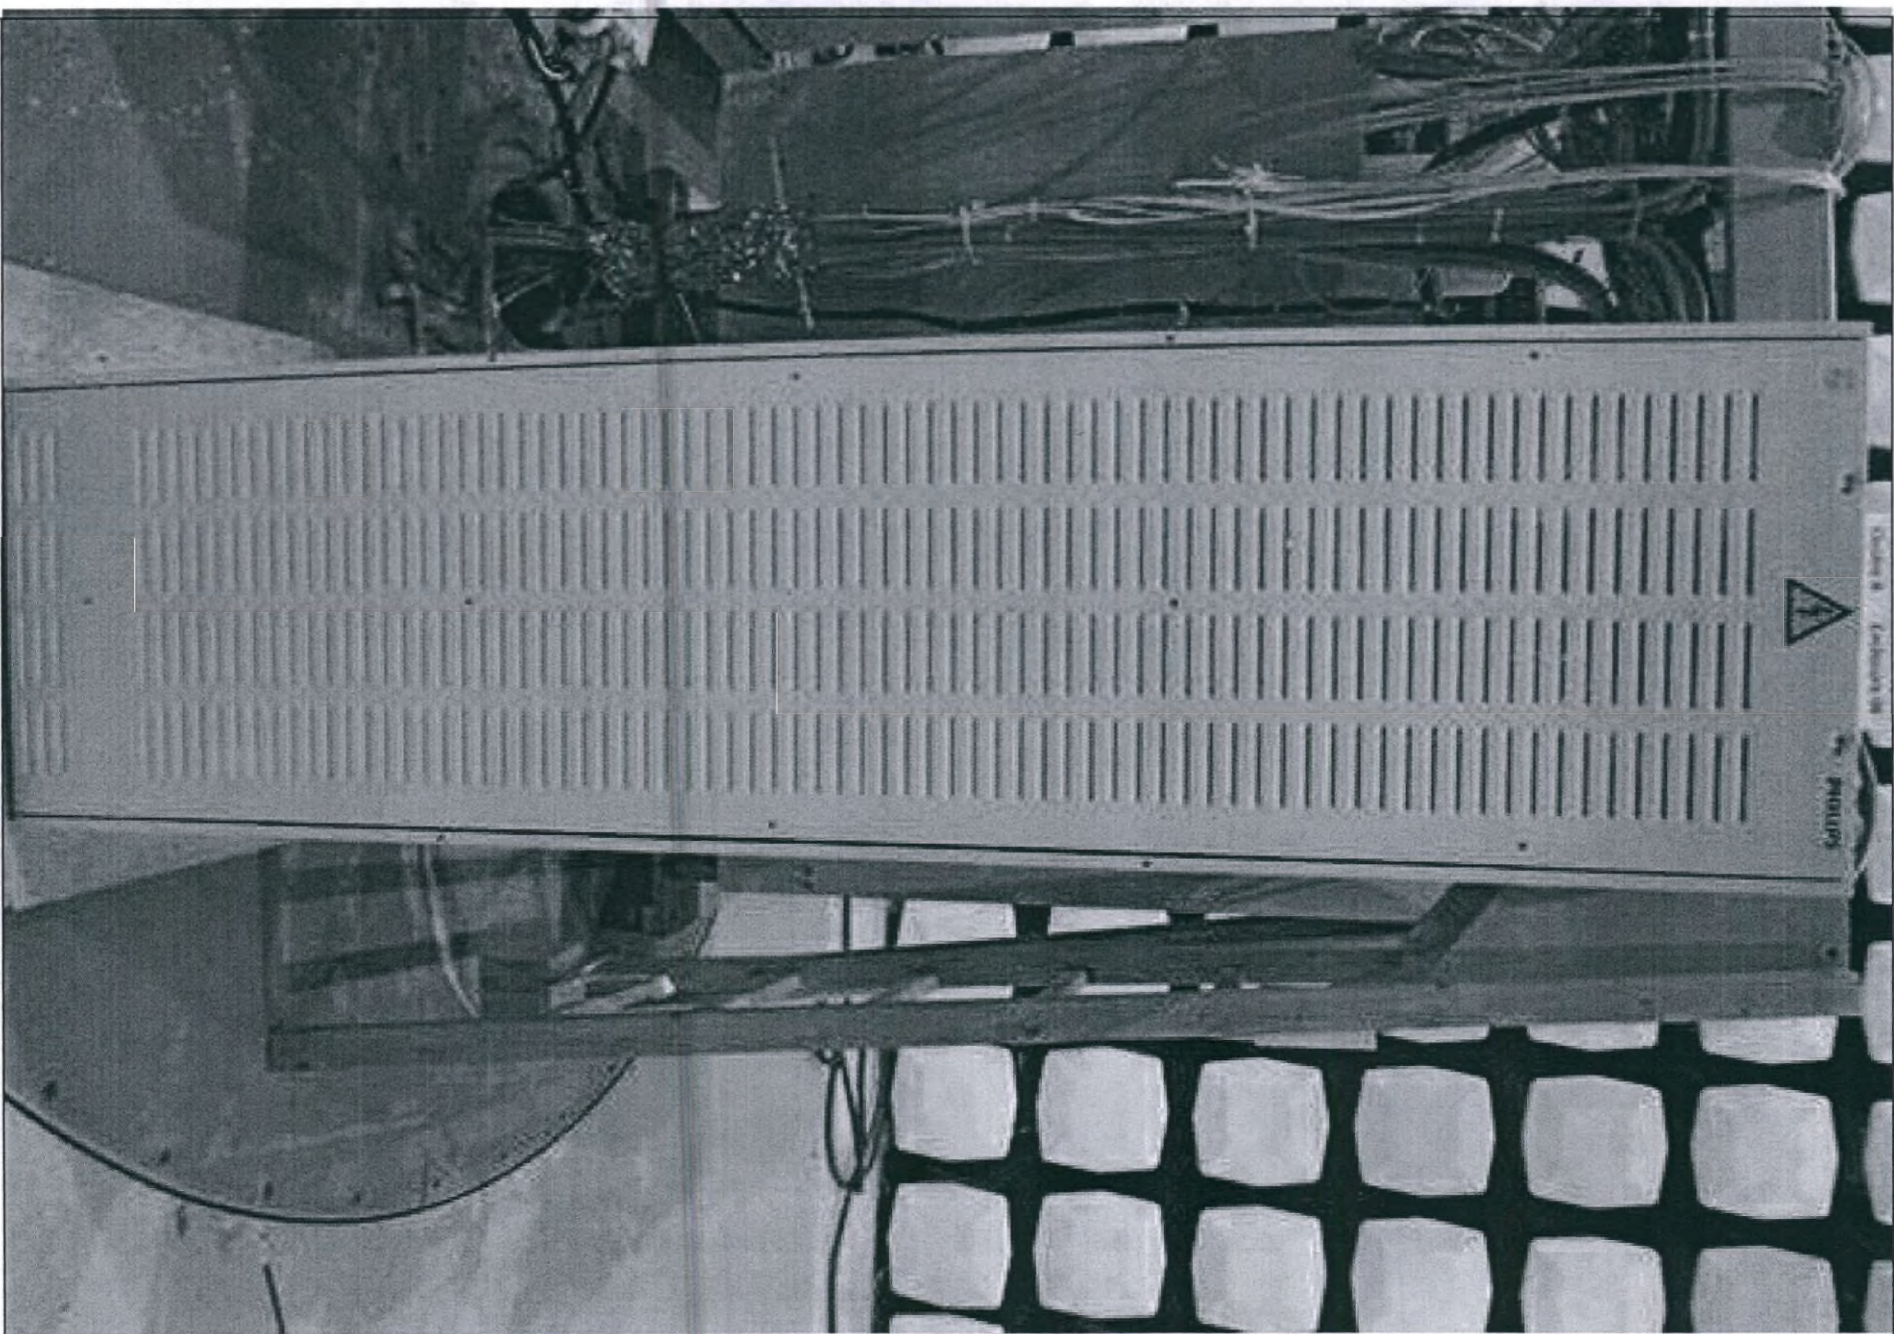

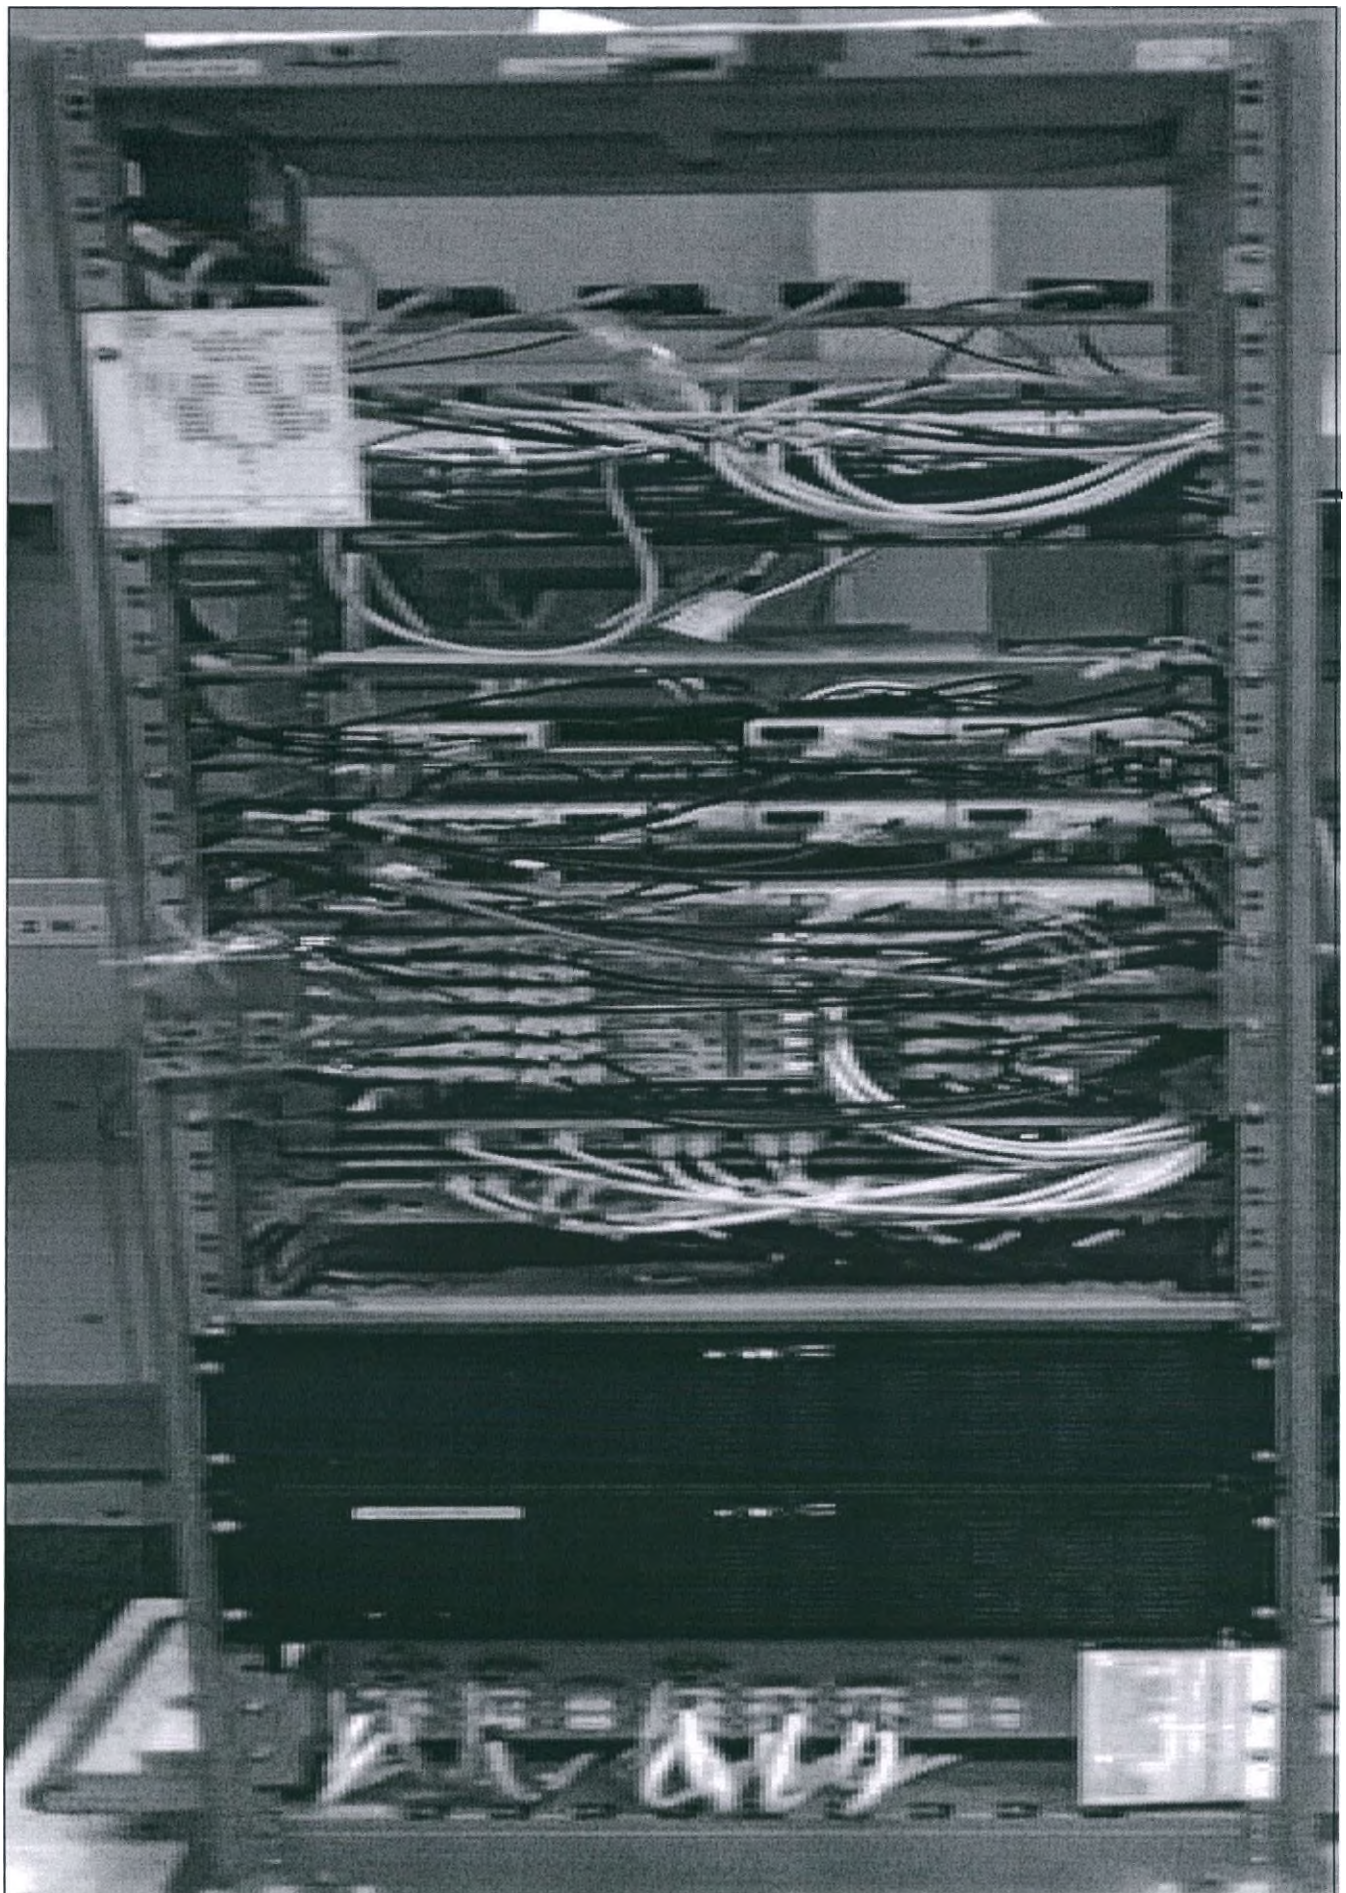


57.а. Распределительный шкаф для монитора

57.б. Распределительный шкаф для монитора

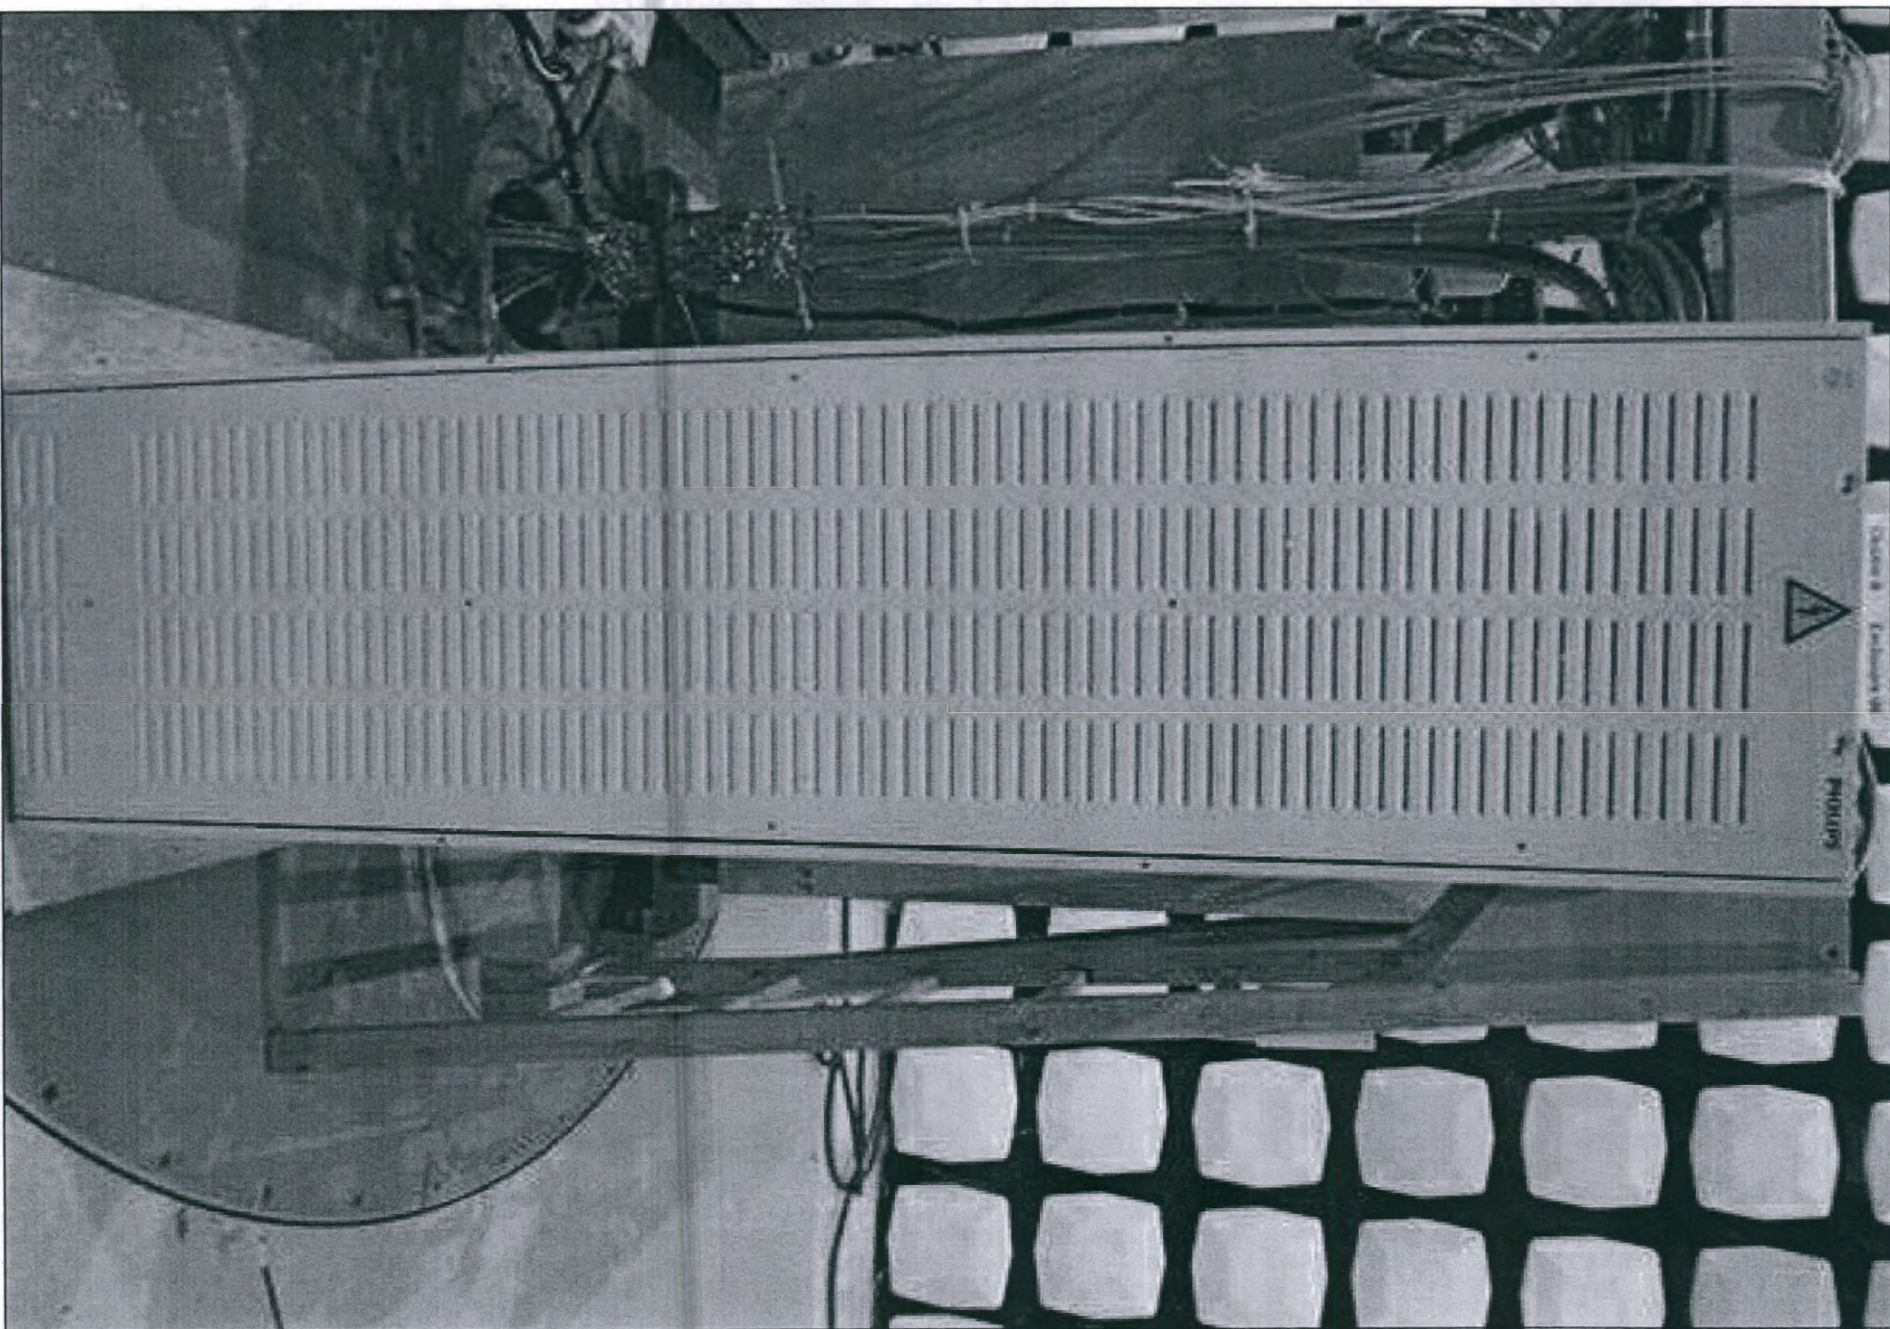




58. Источник бесперебойного питания с полной нагрузкой.

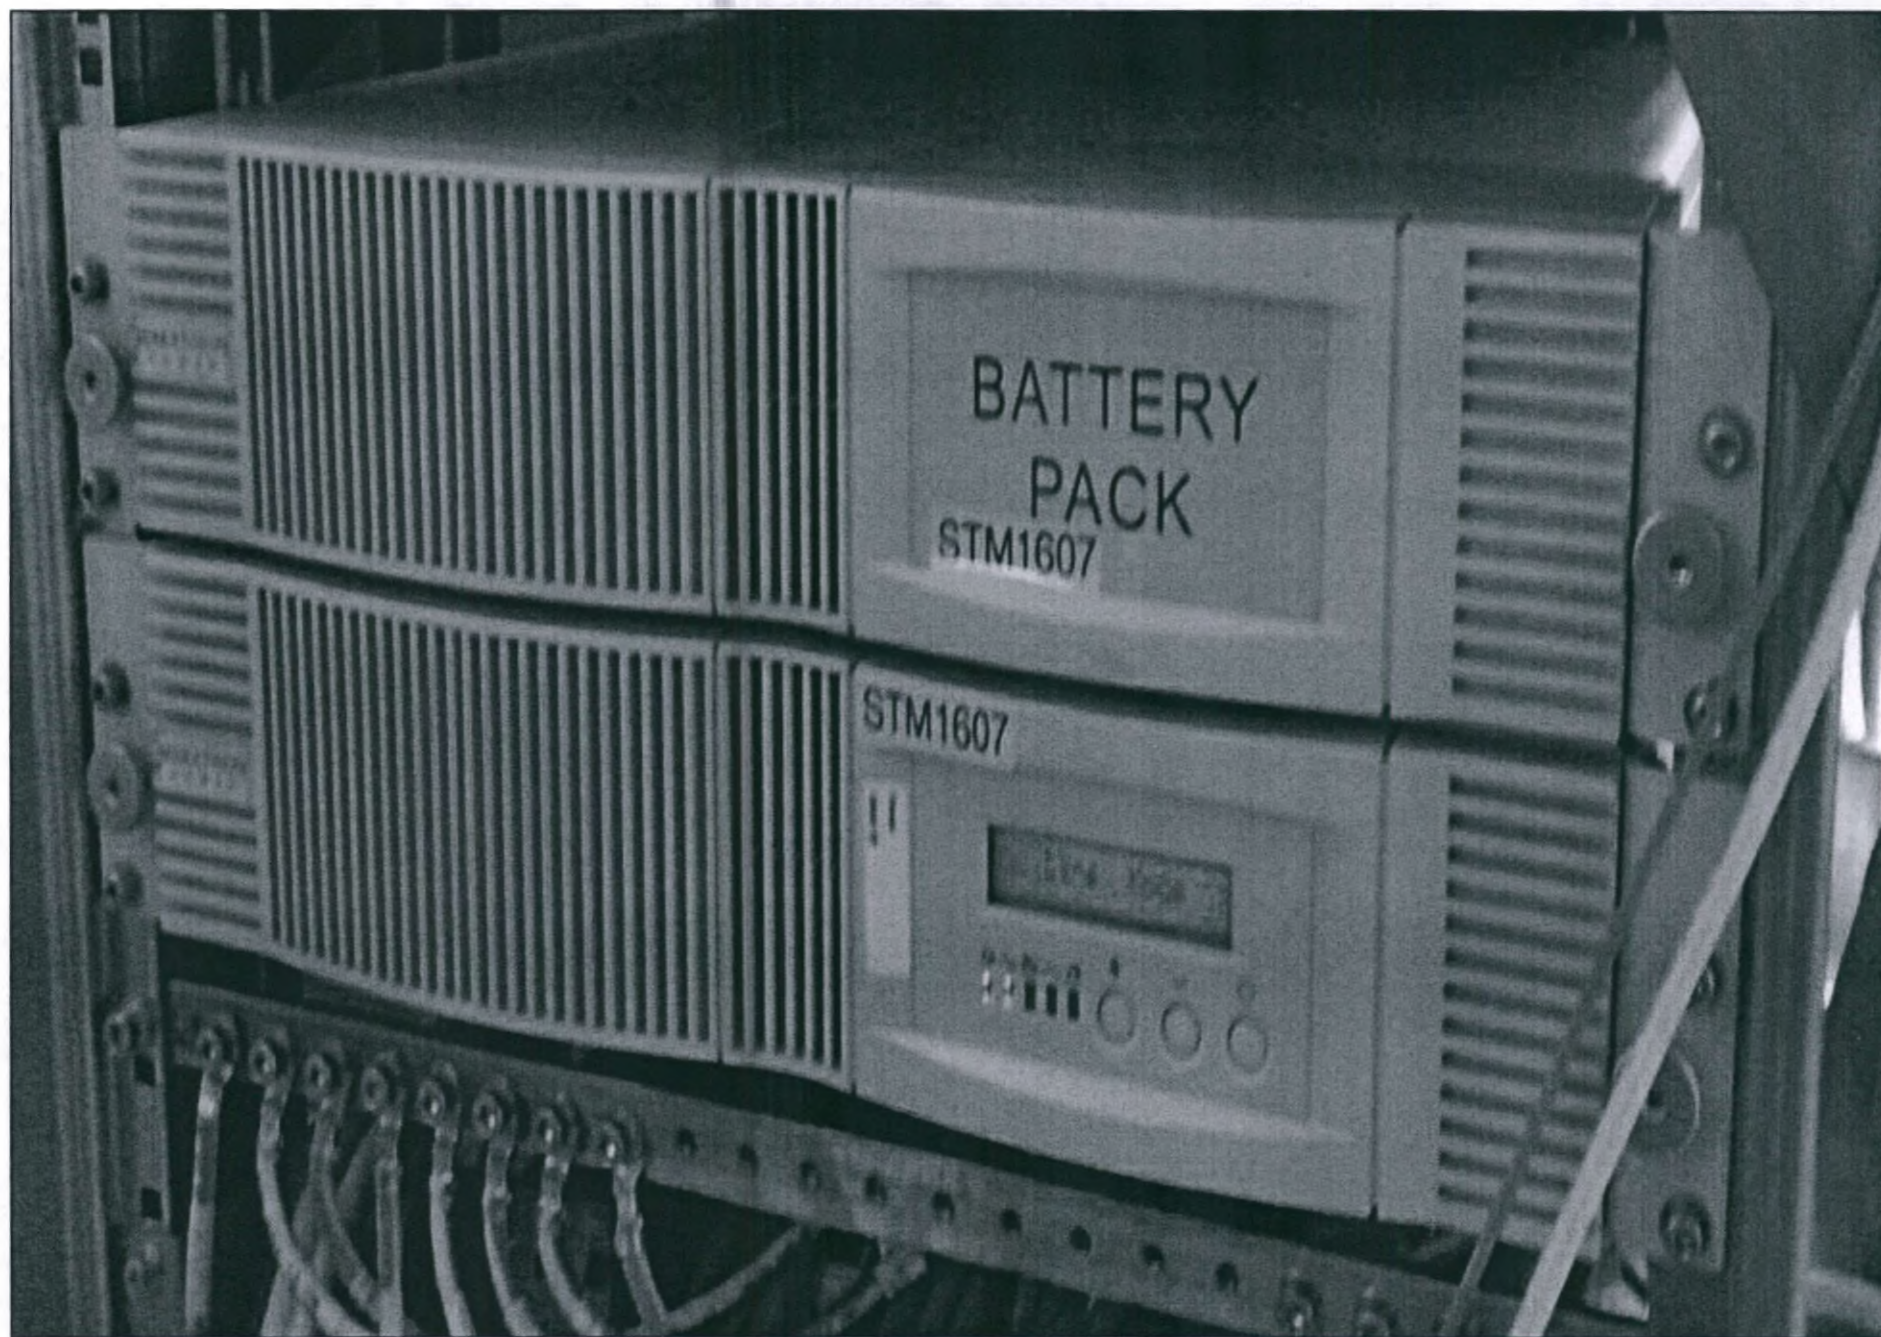


59. Источник бесперебойного питания с малой нагрузкой



60. Автотрансформатор

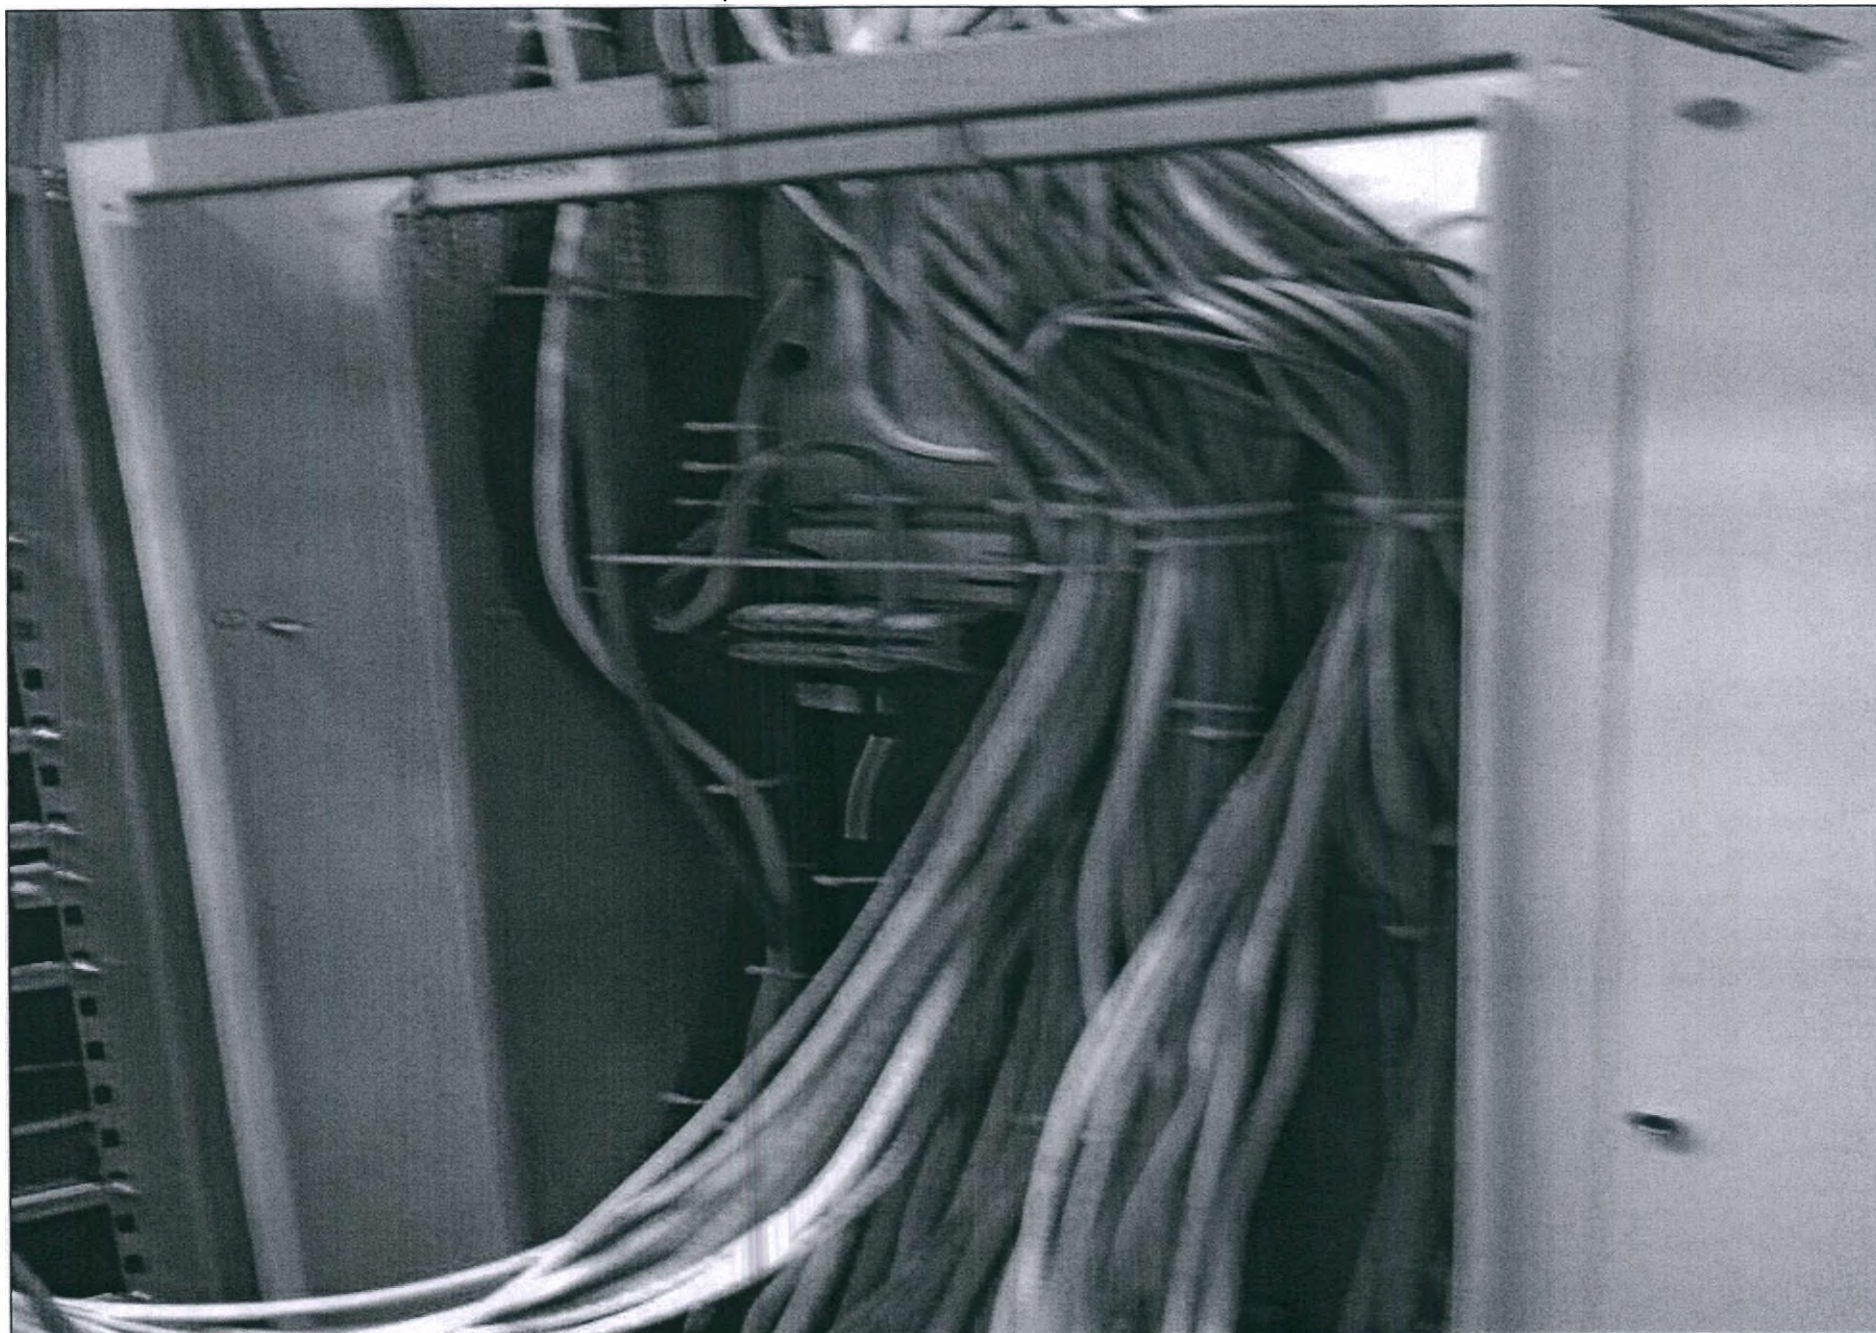


61.а. Крышки для технических блоков в пультовой

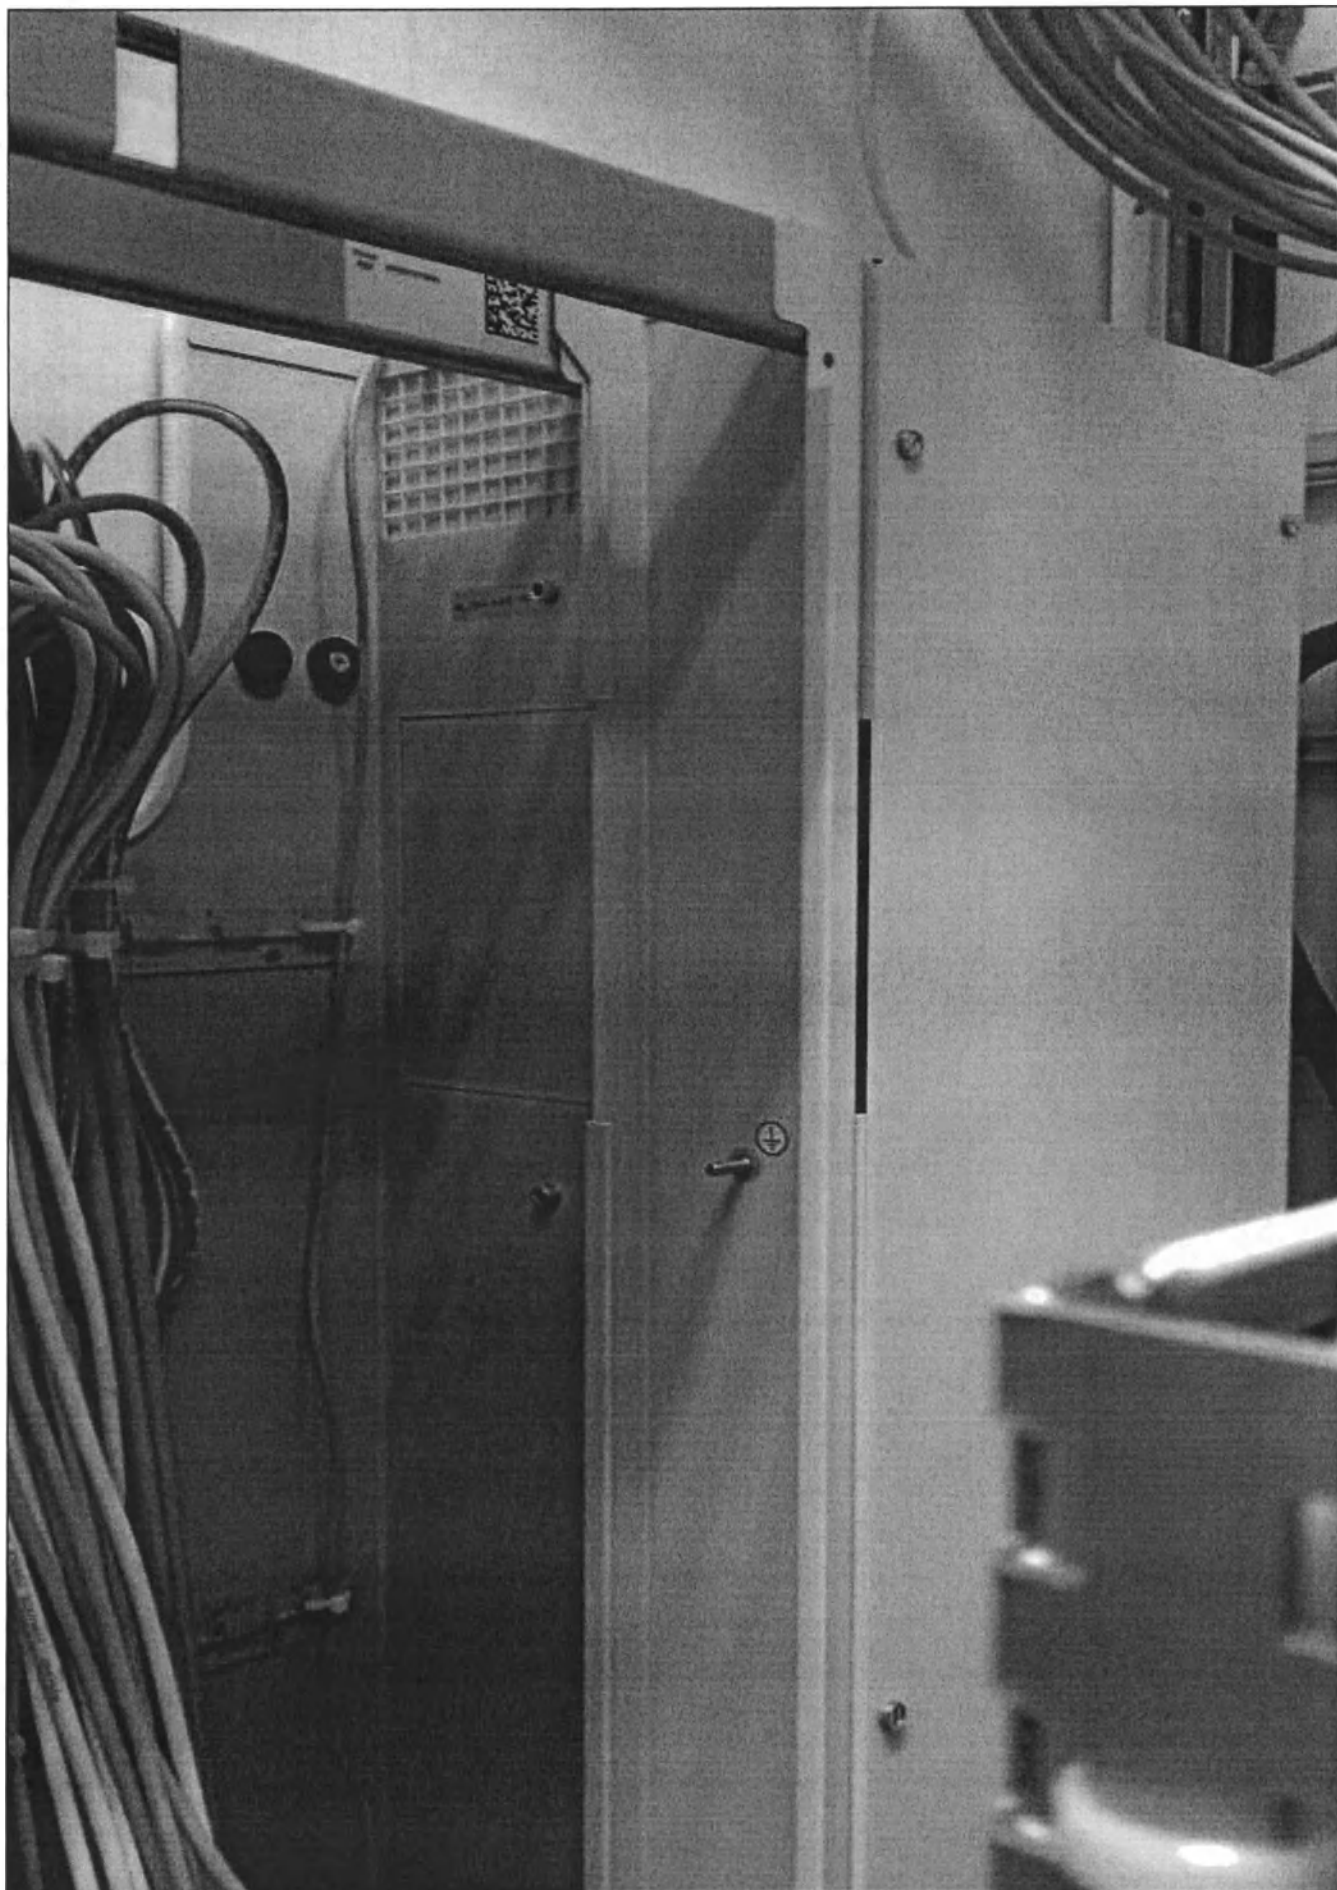


61.б. Крышки для технических блоков в пультовой



62. Напольная плита для штатива С-дуги.

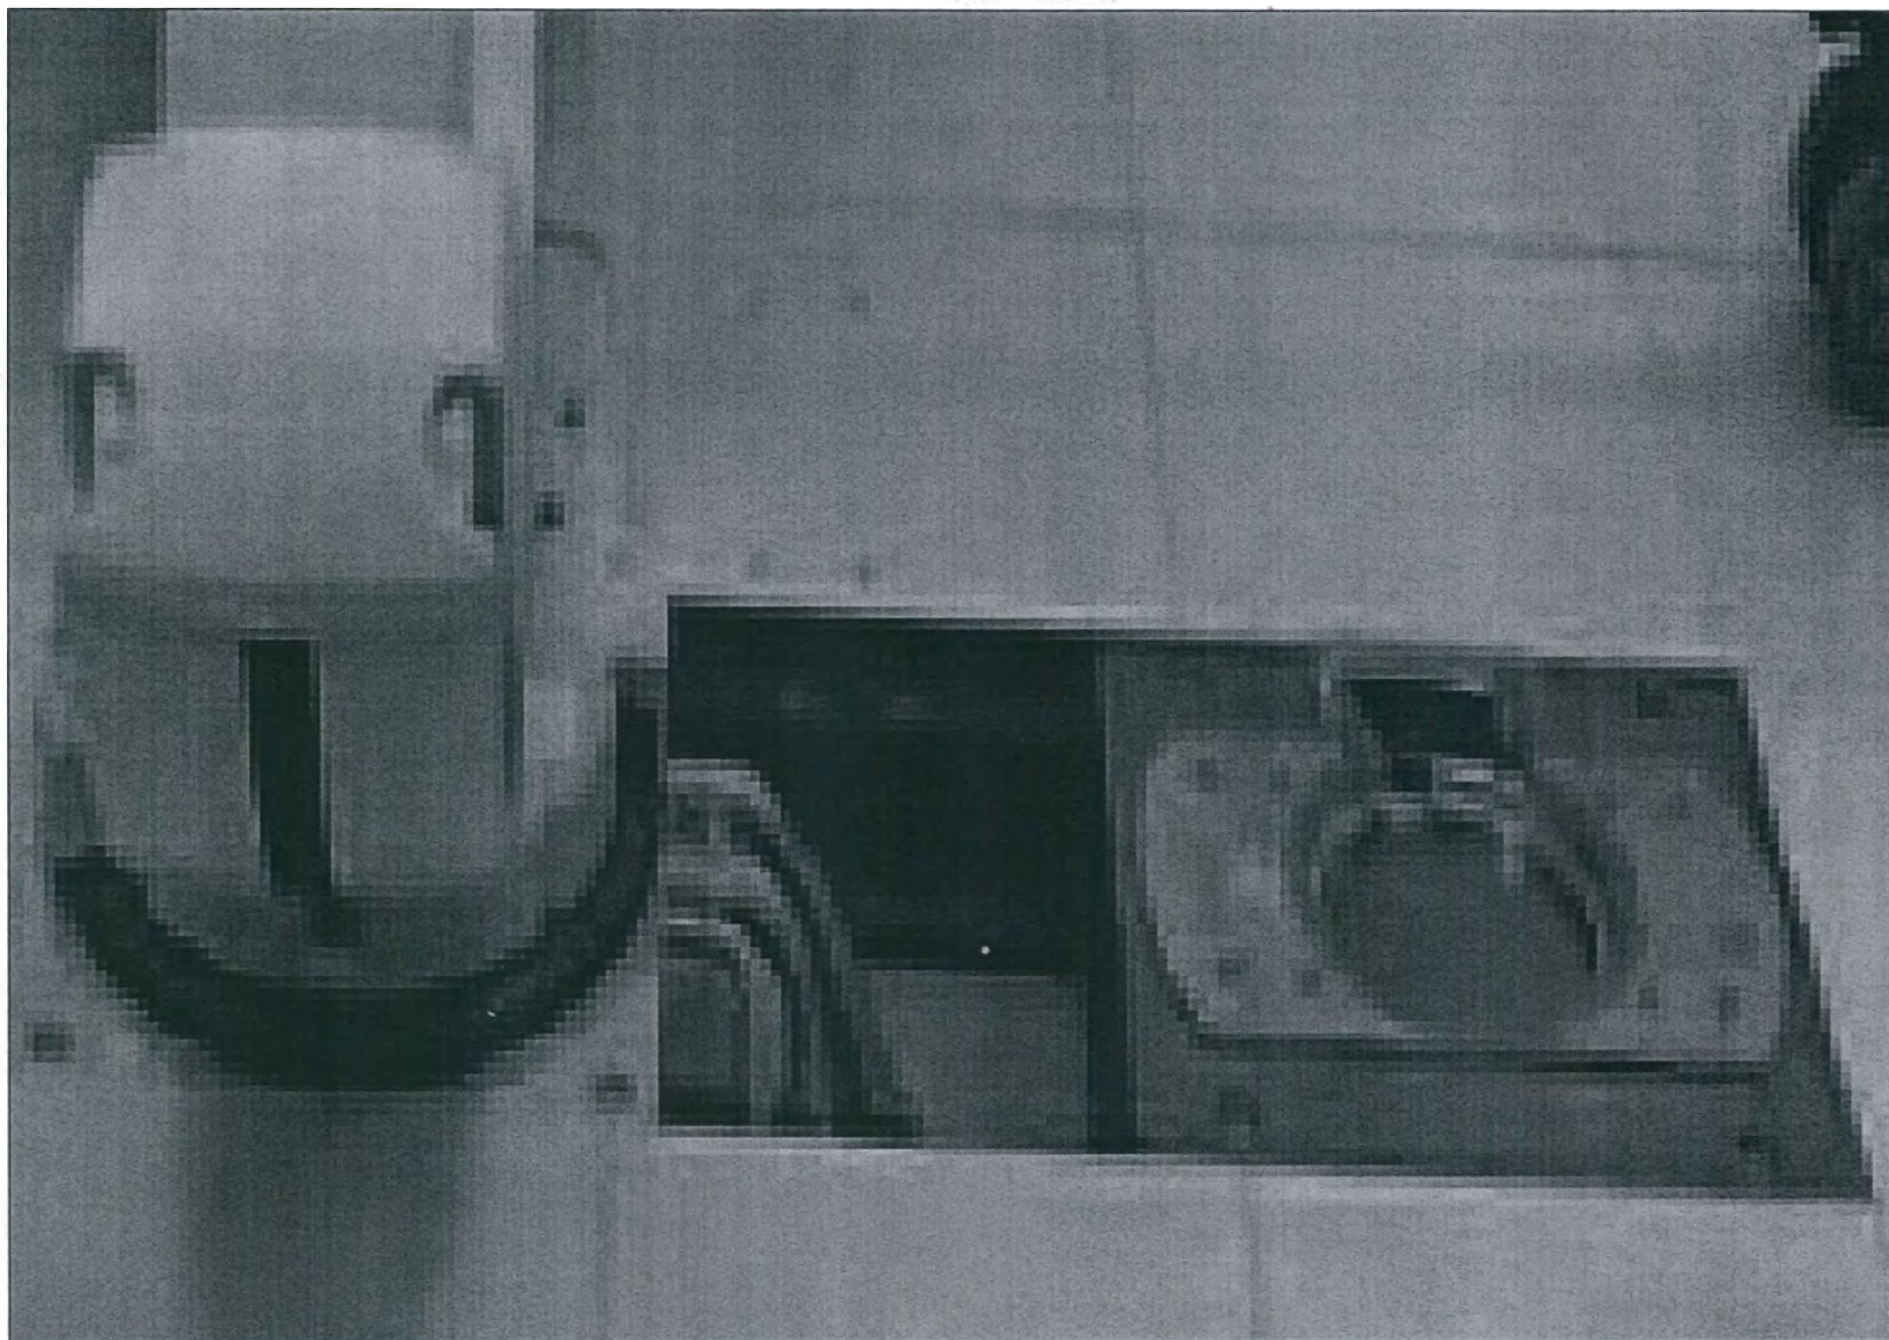


63.а. Напольная плита для установки стола пациента.

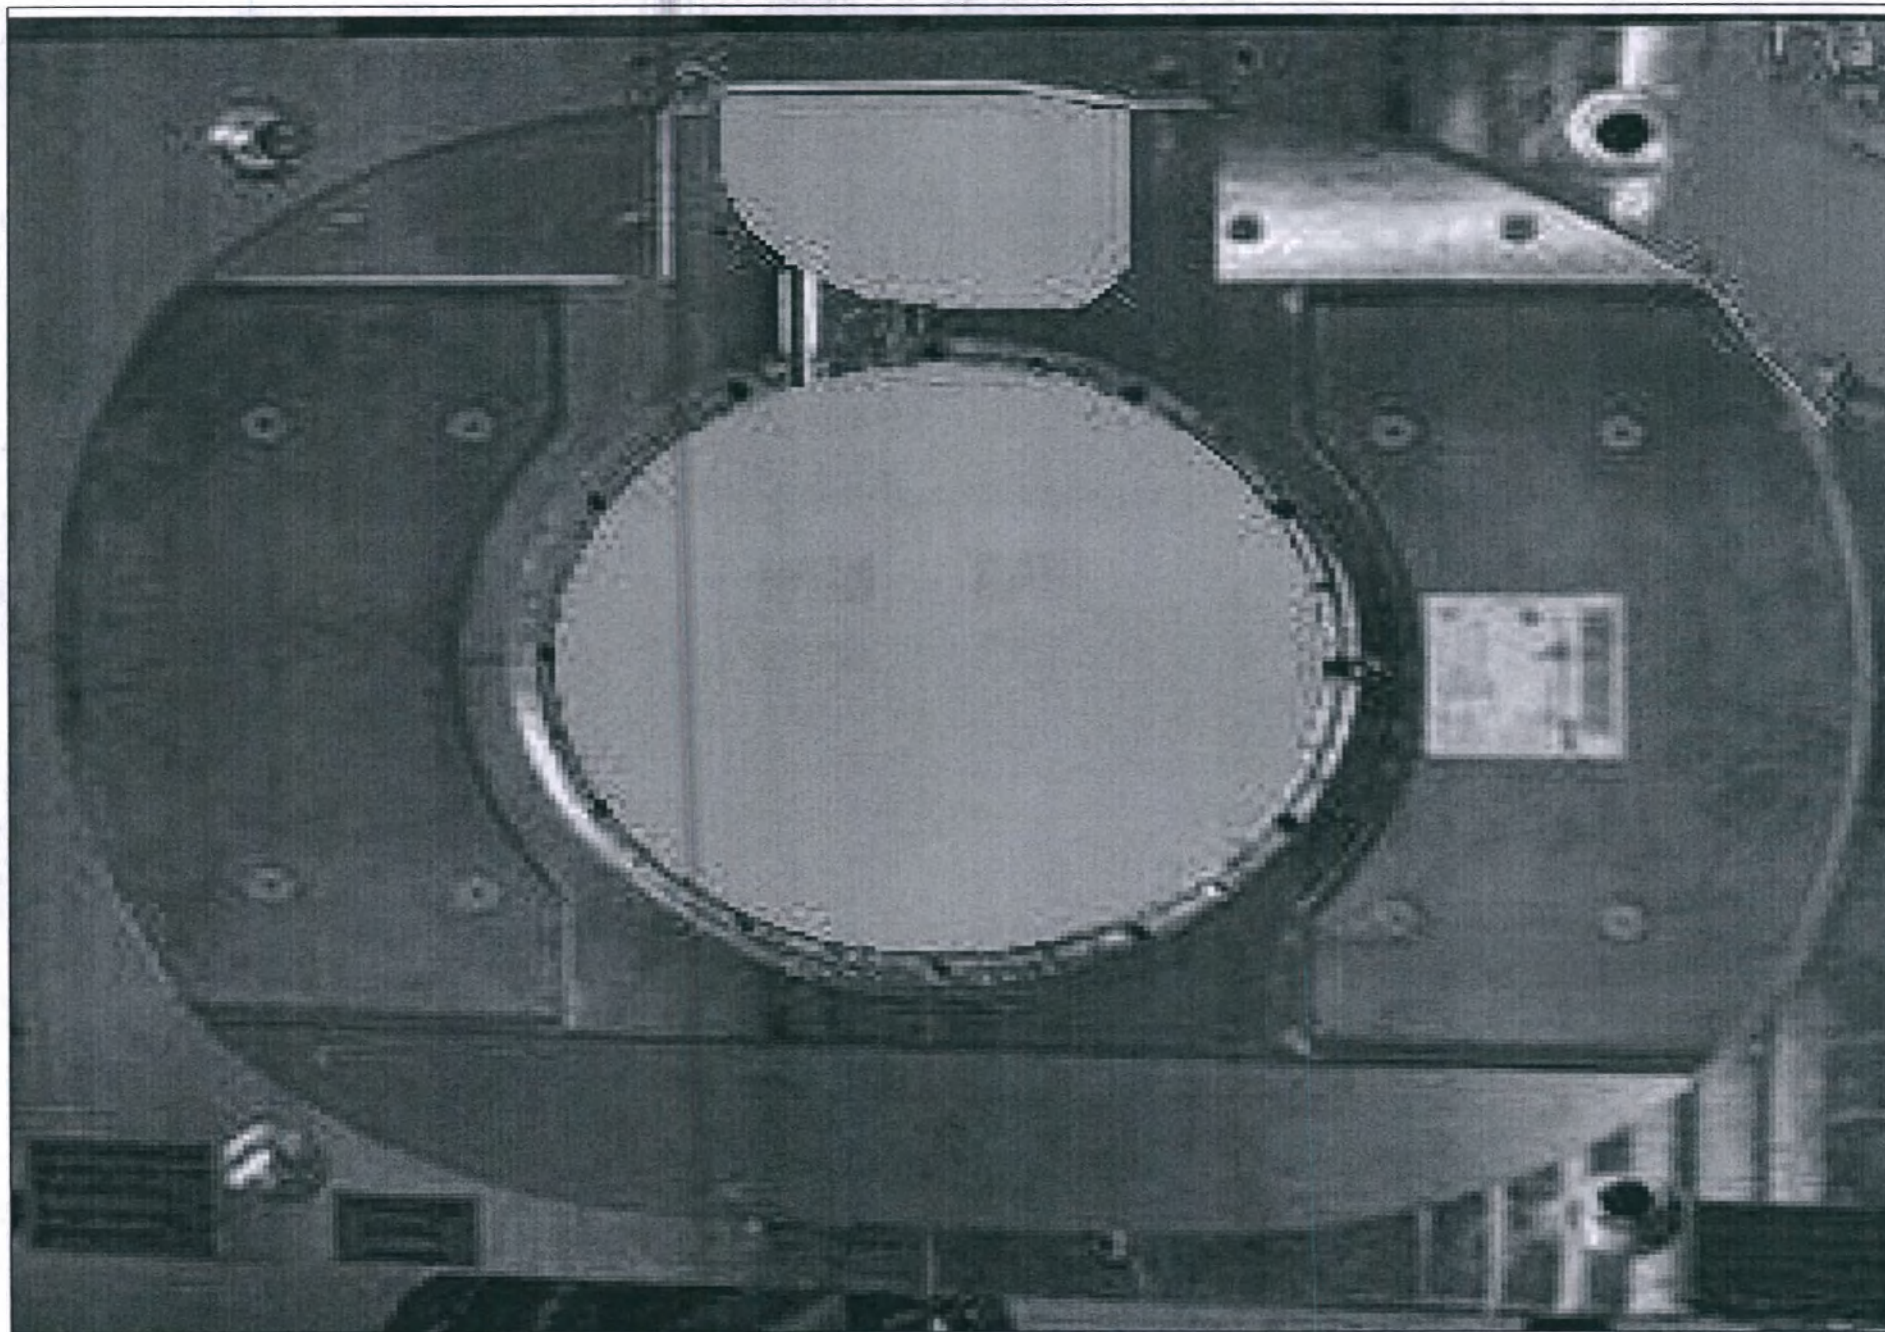


63.6. Напольная плита для установки стола пациента.




64. Рельсы потолочные для С-дуги

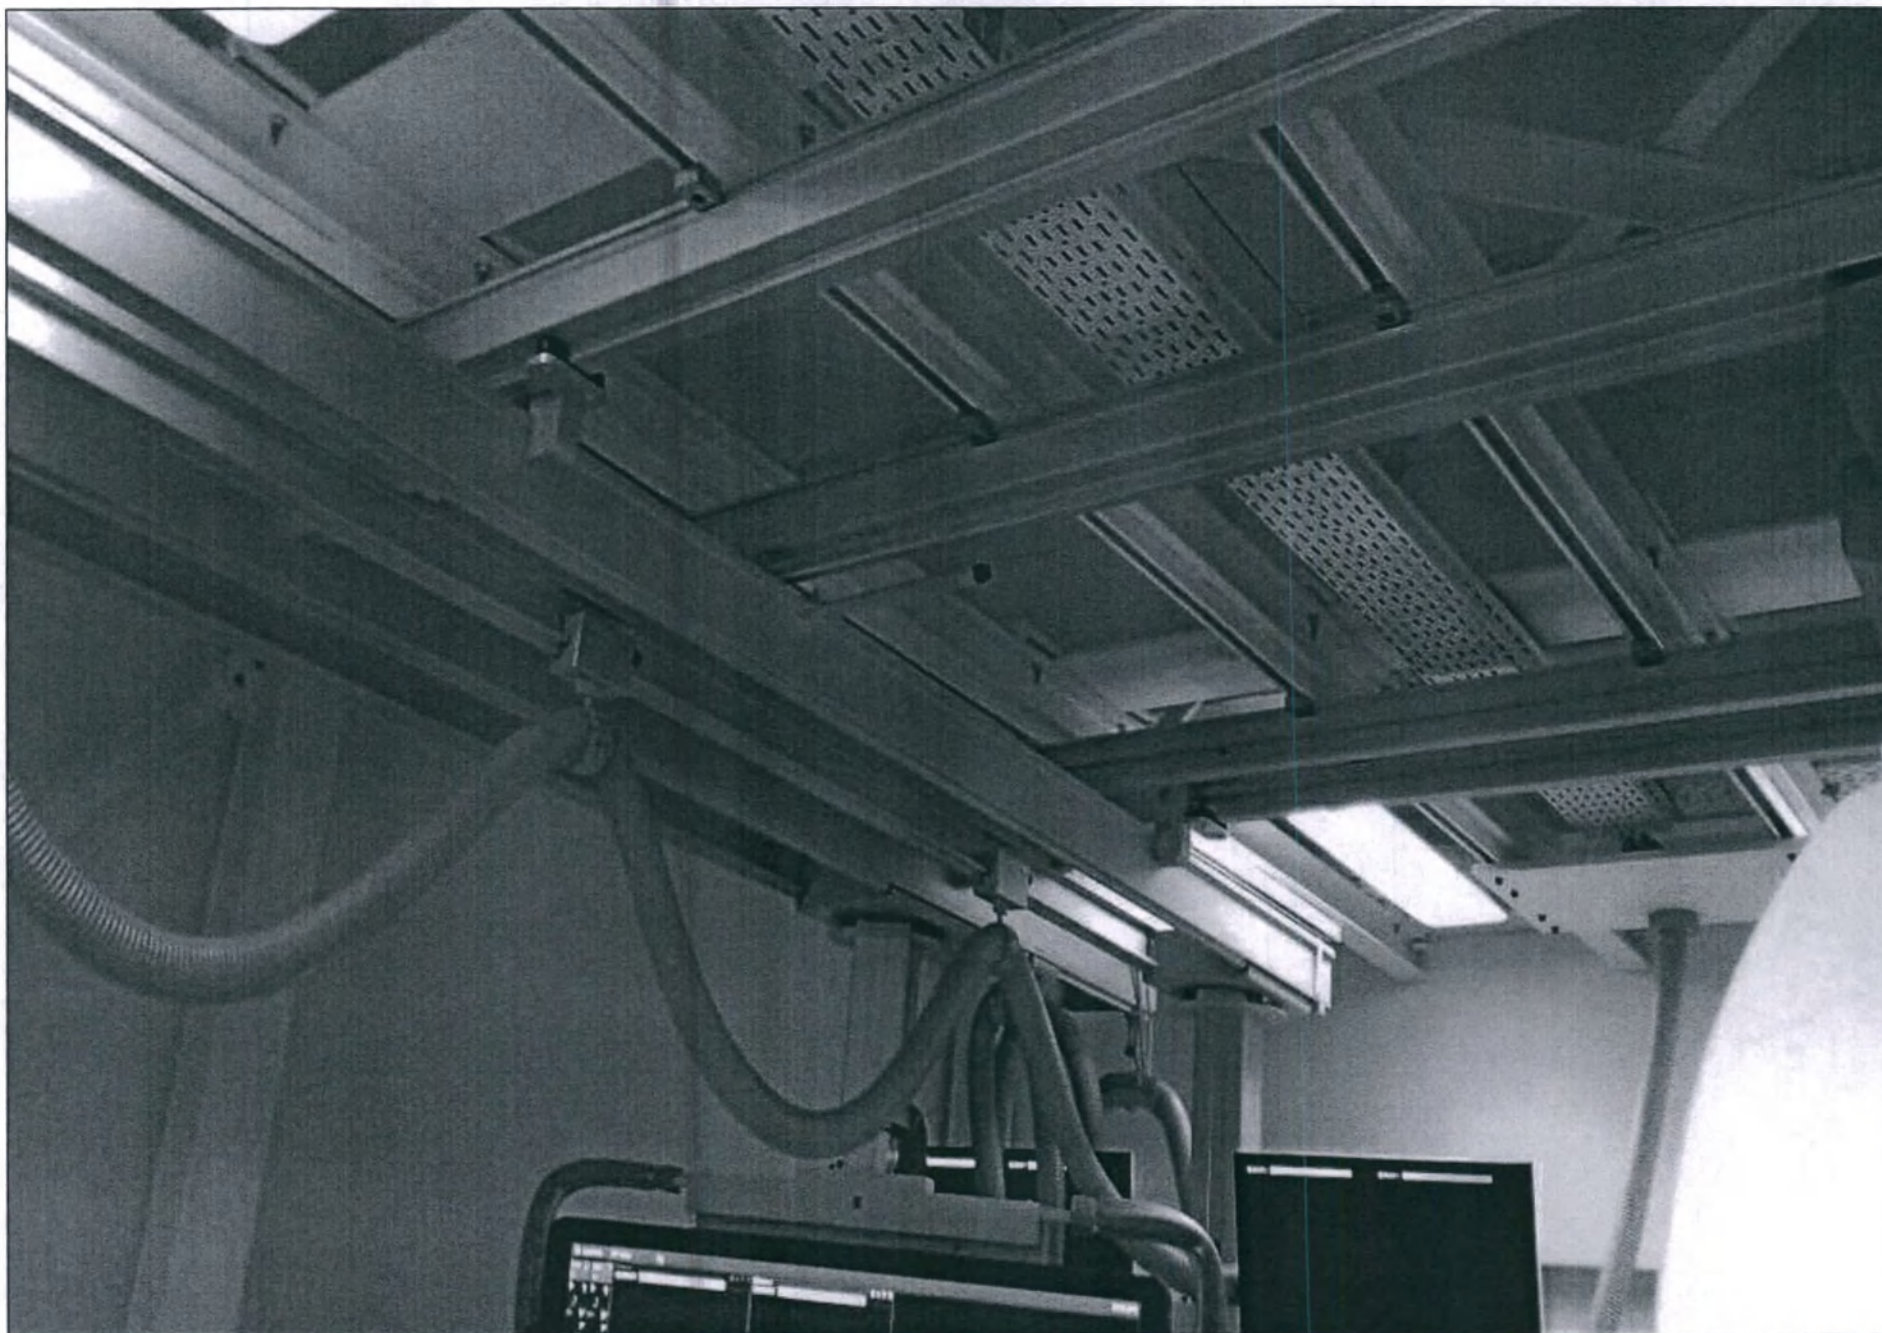


65. Рельсы потолочные для мониторной подвески

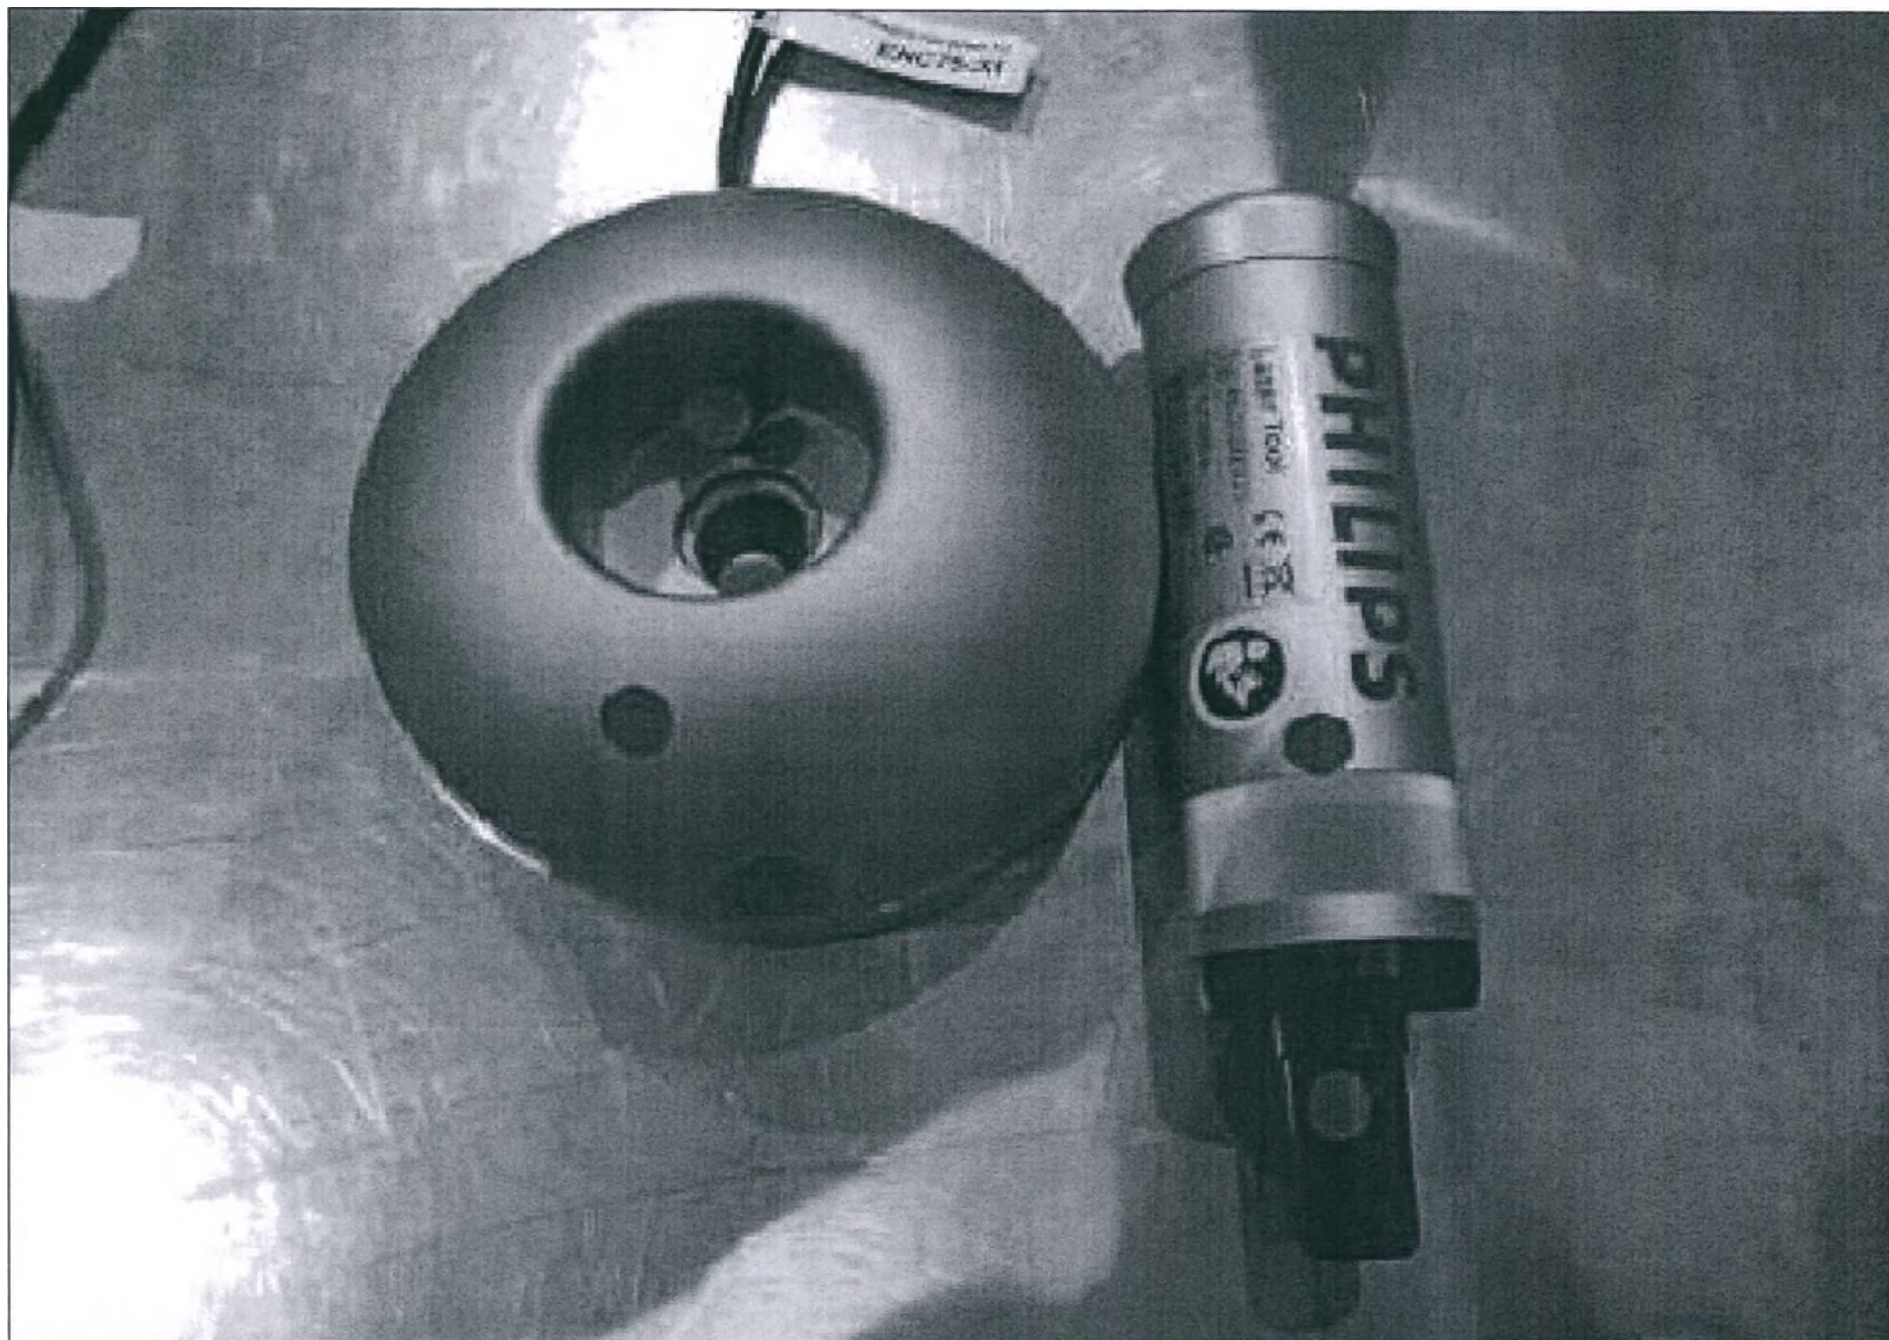


66. Лазерный центратор.

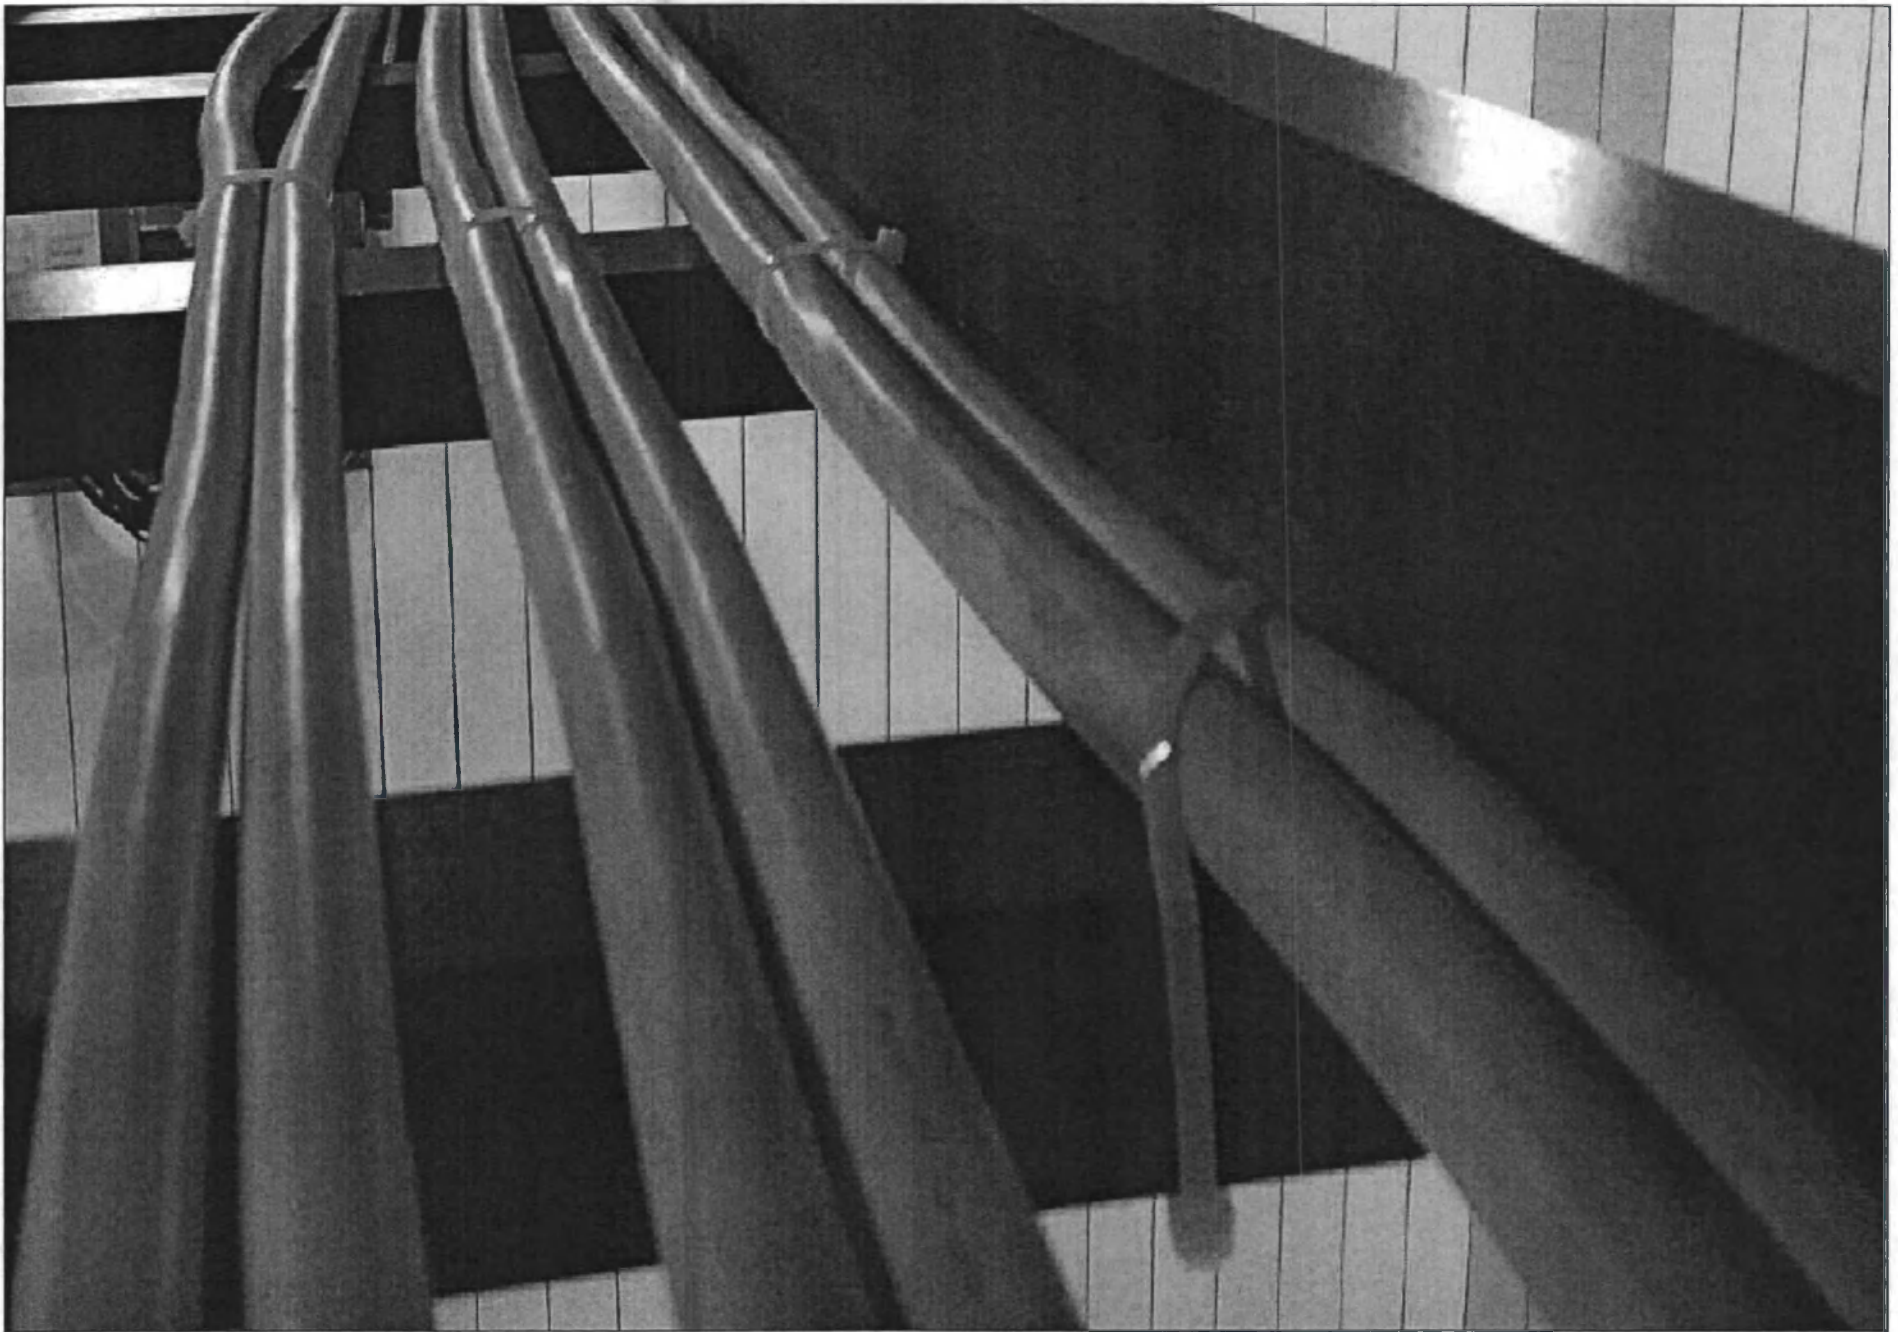


67. Кабели соединительные

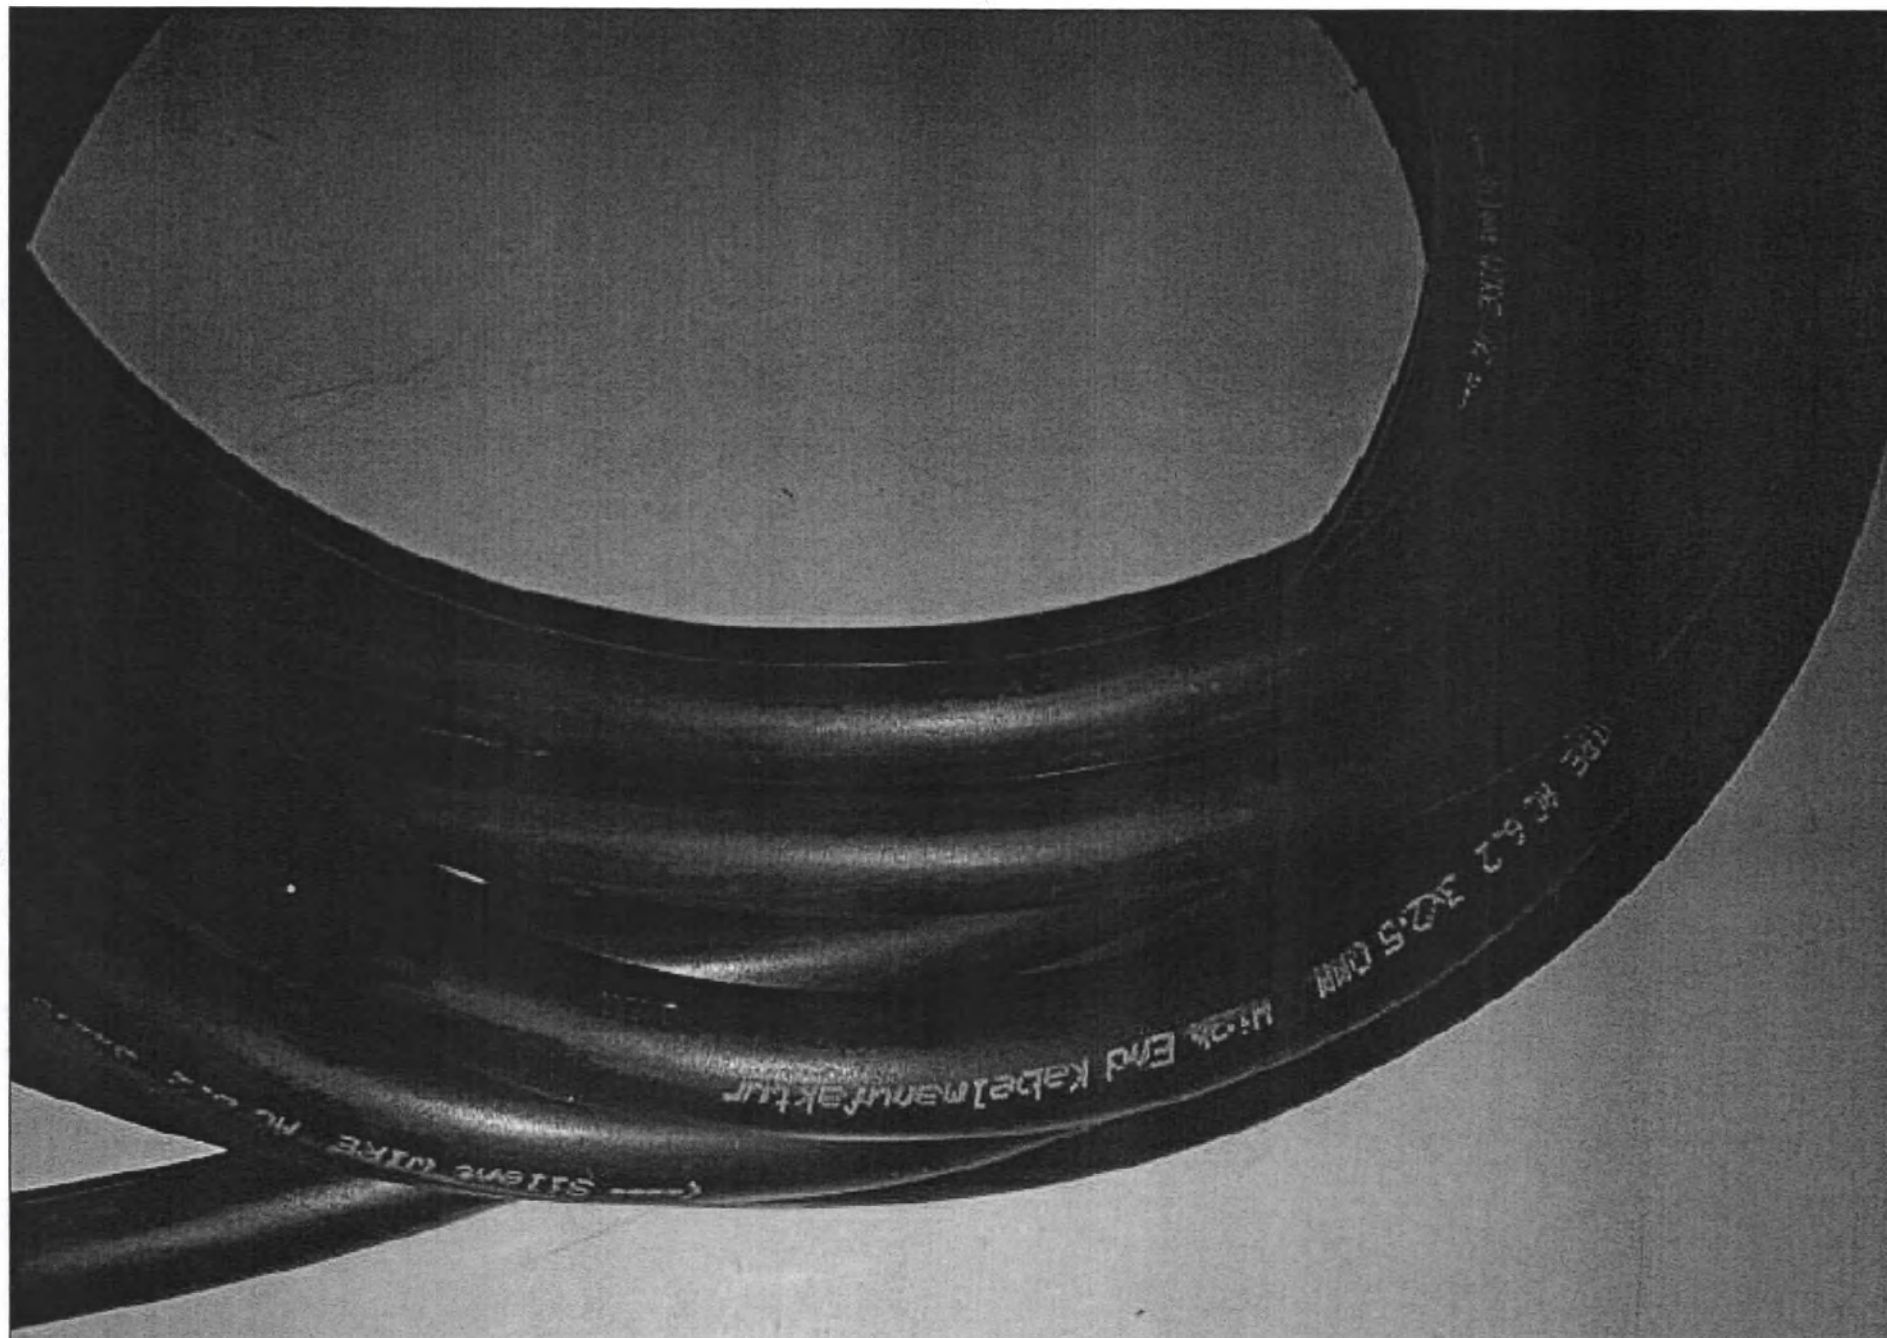


68. Кабели силовые

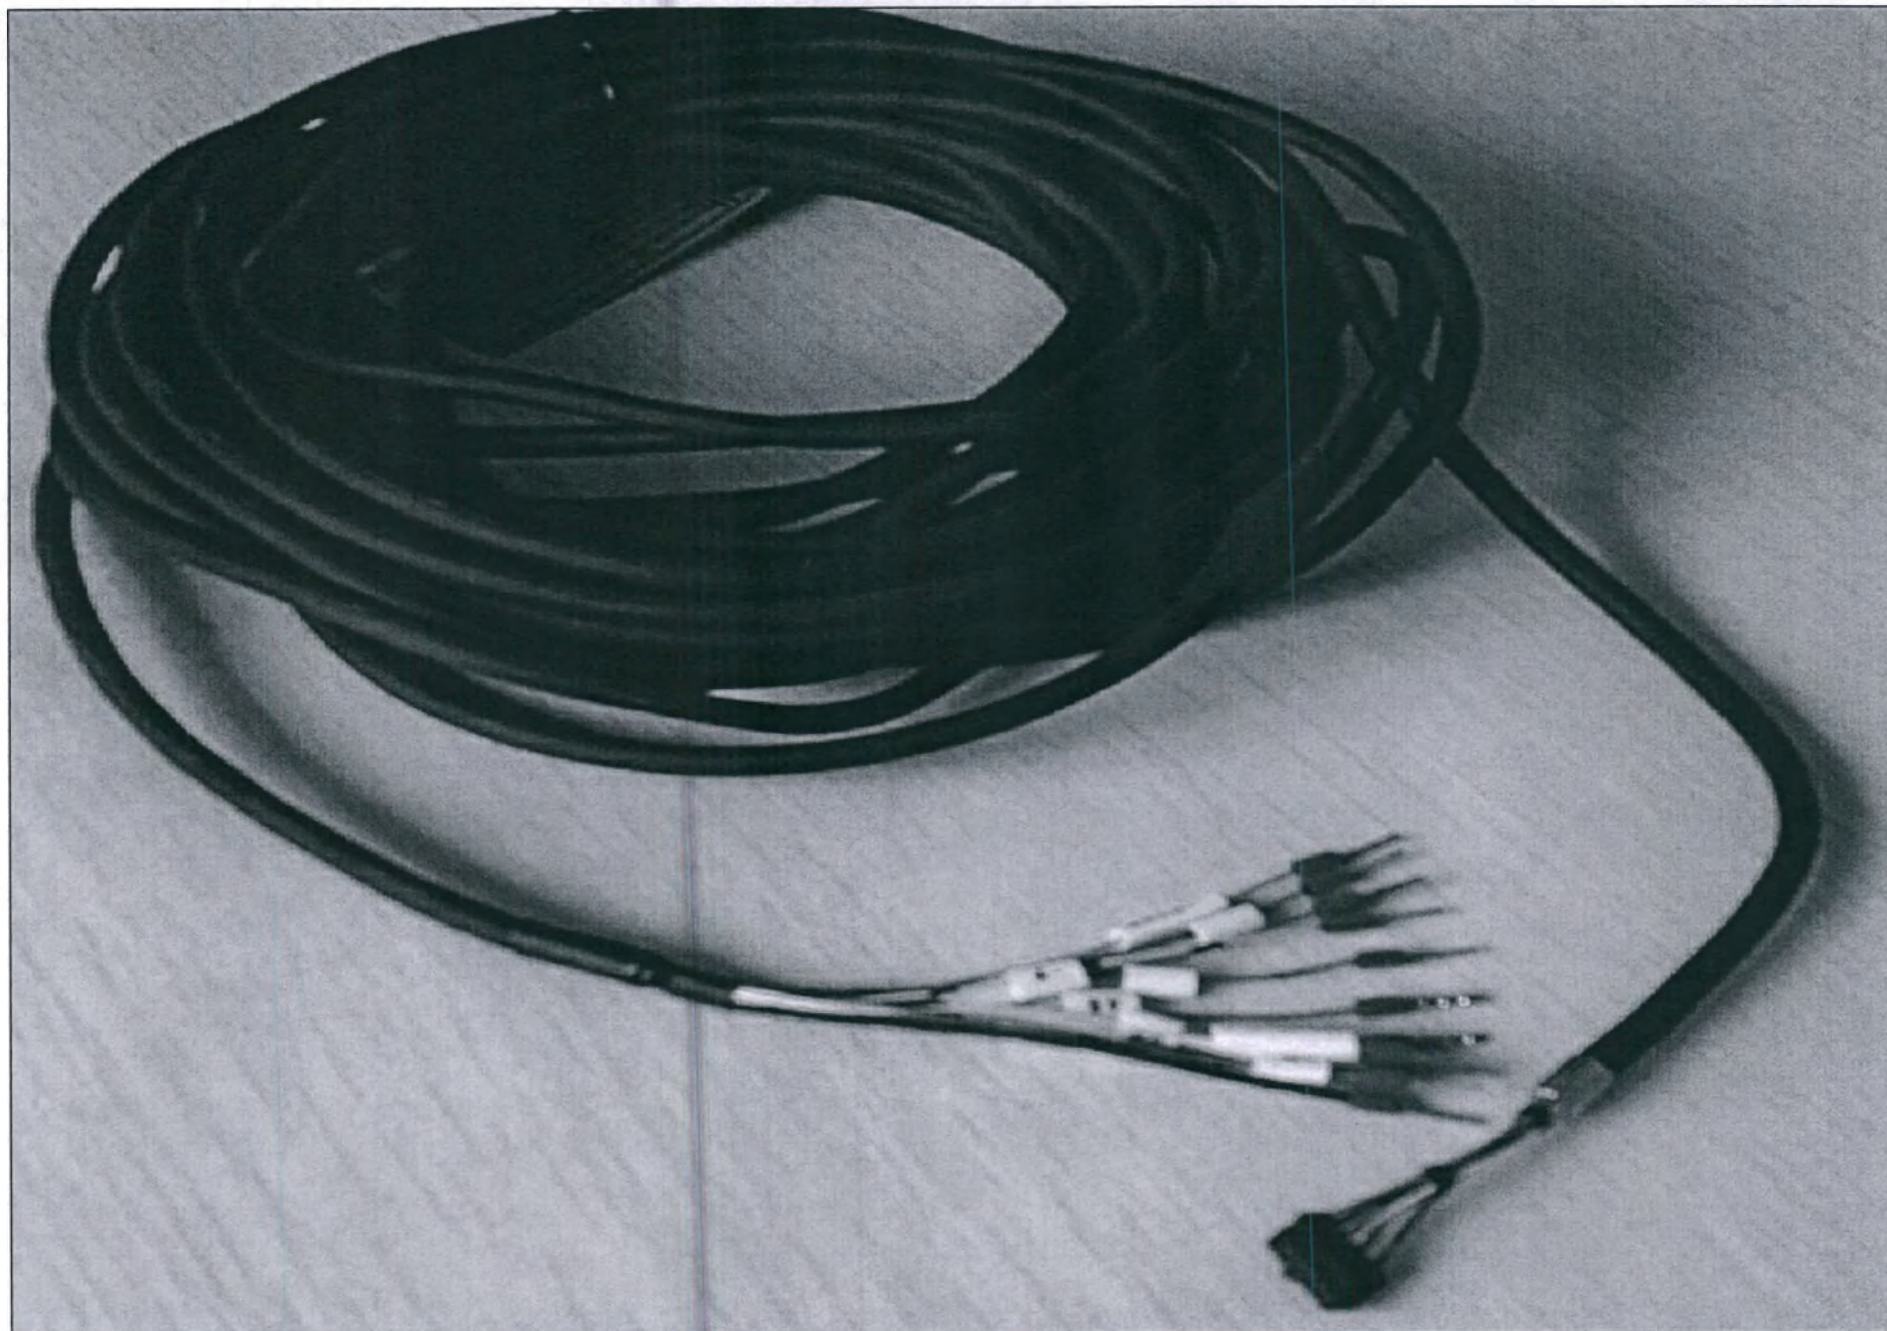


69. Комплект кабеля с разъемами длиной 8 м

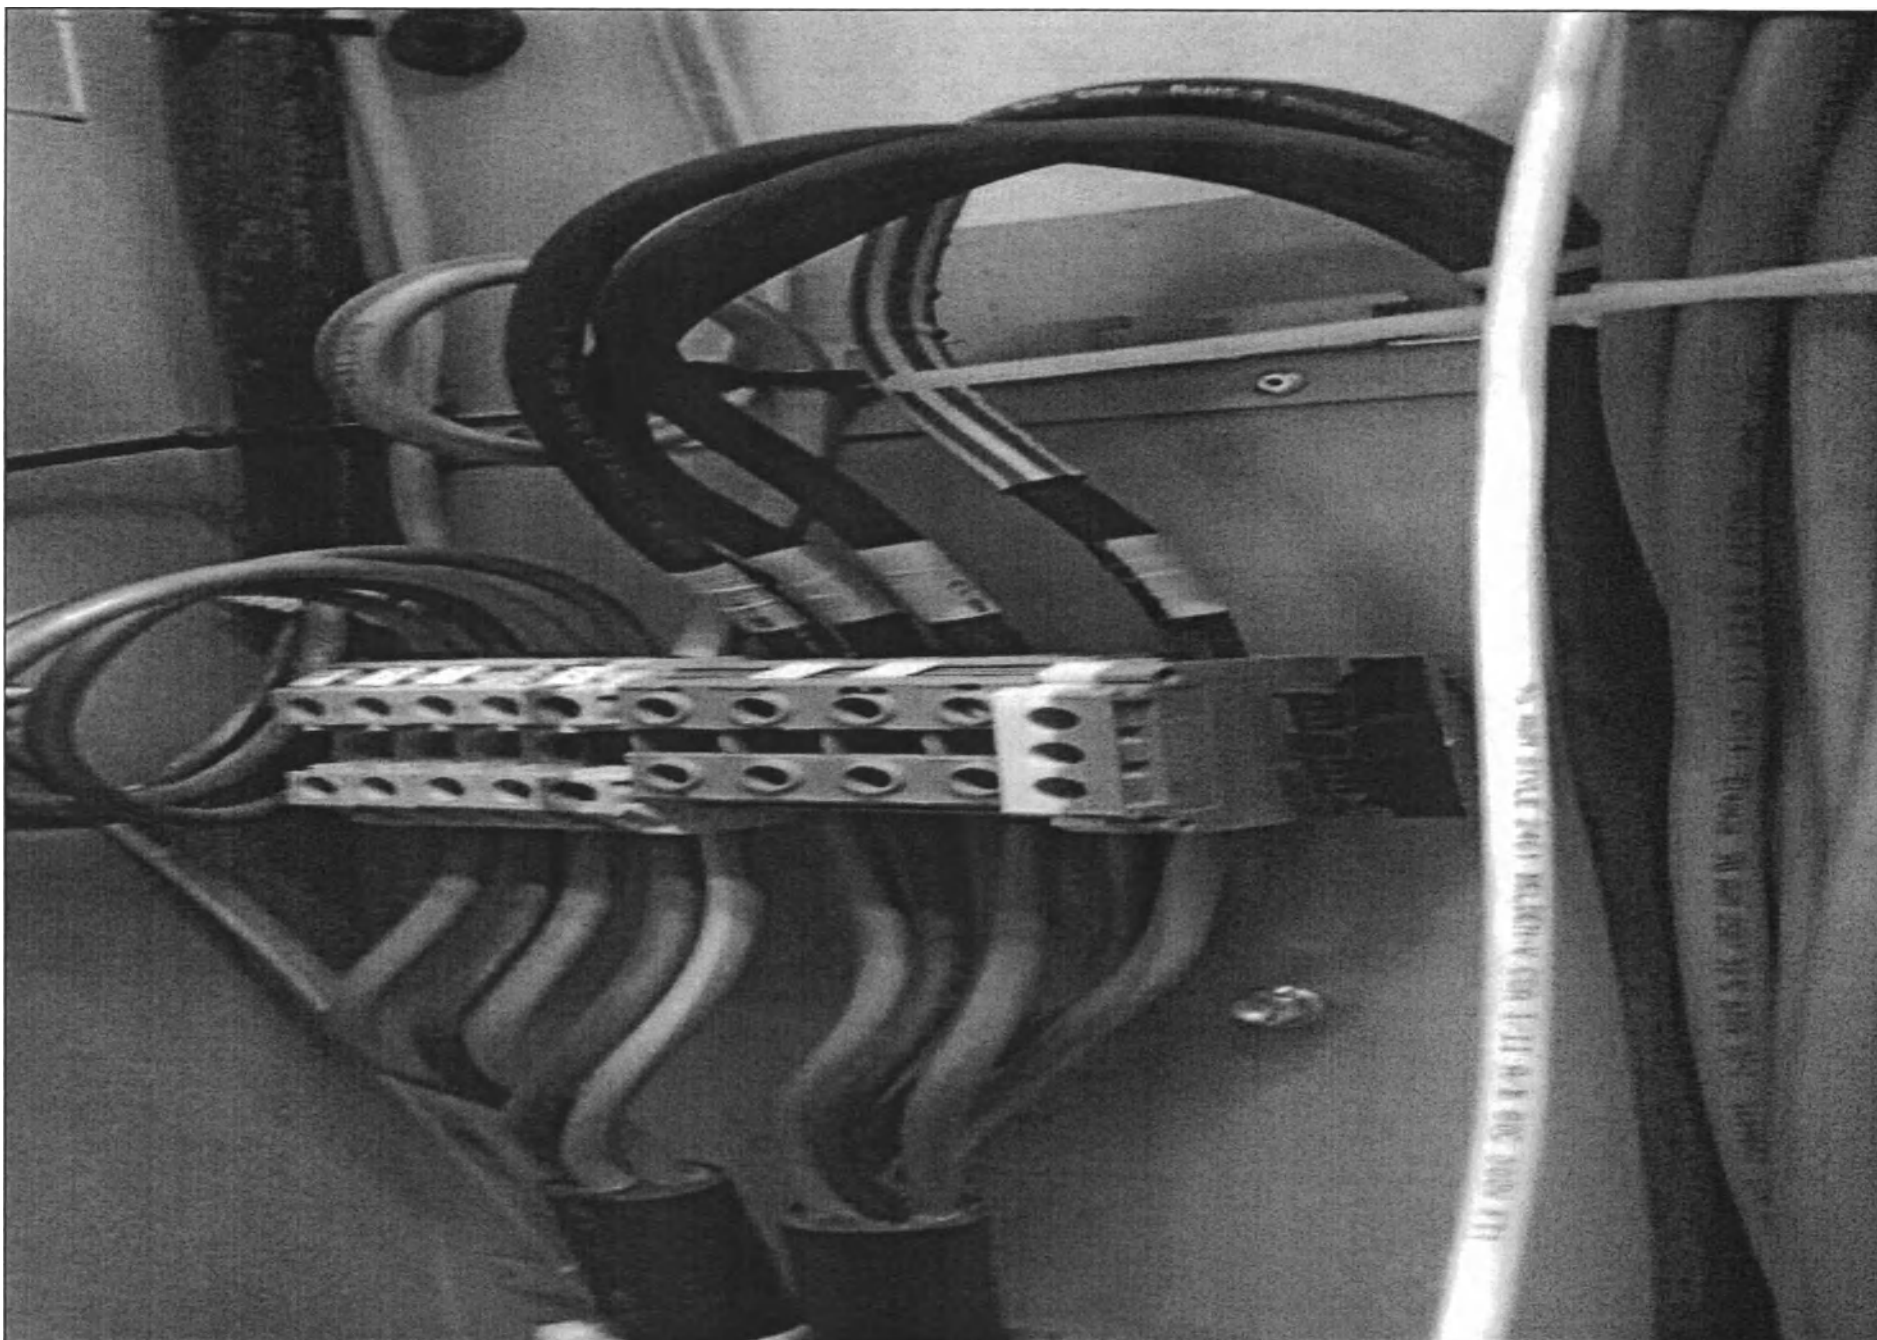


70. Кабели питания резервные

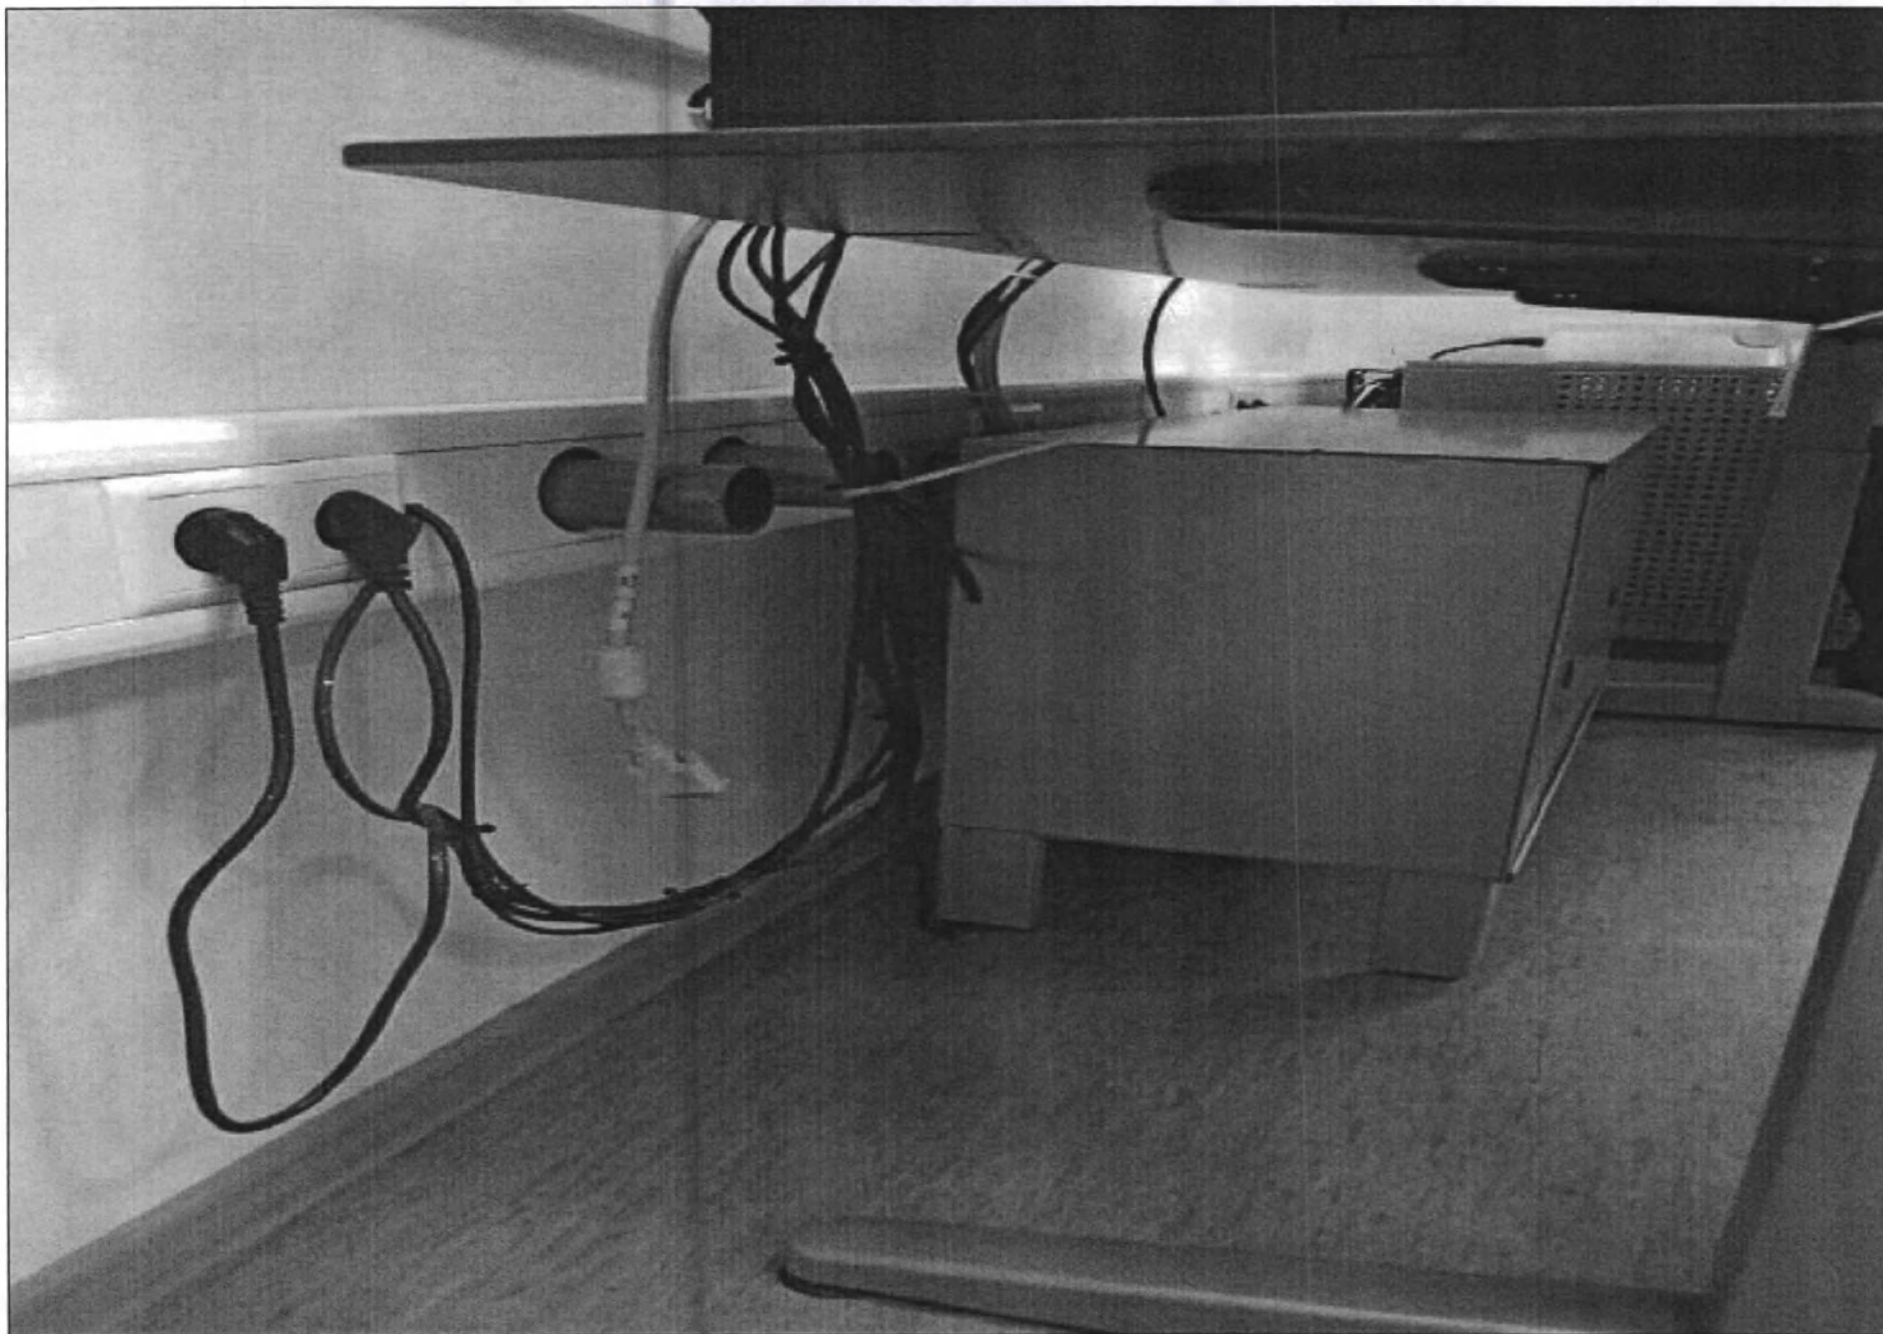

71. Кабели для подключения внешнего оборудования

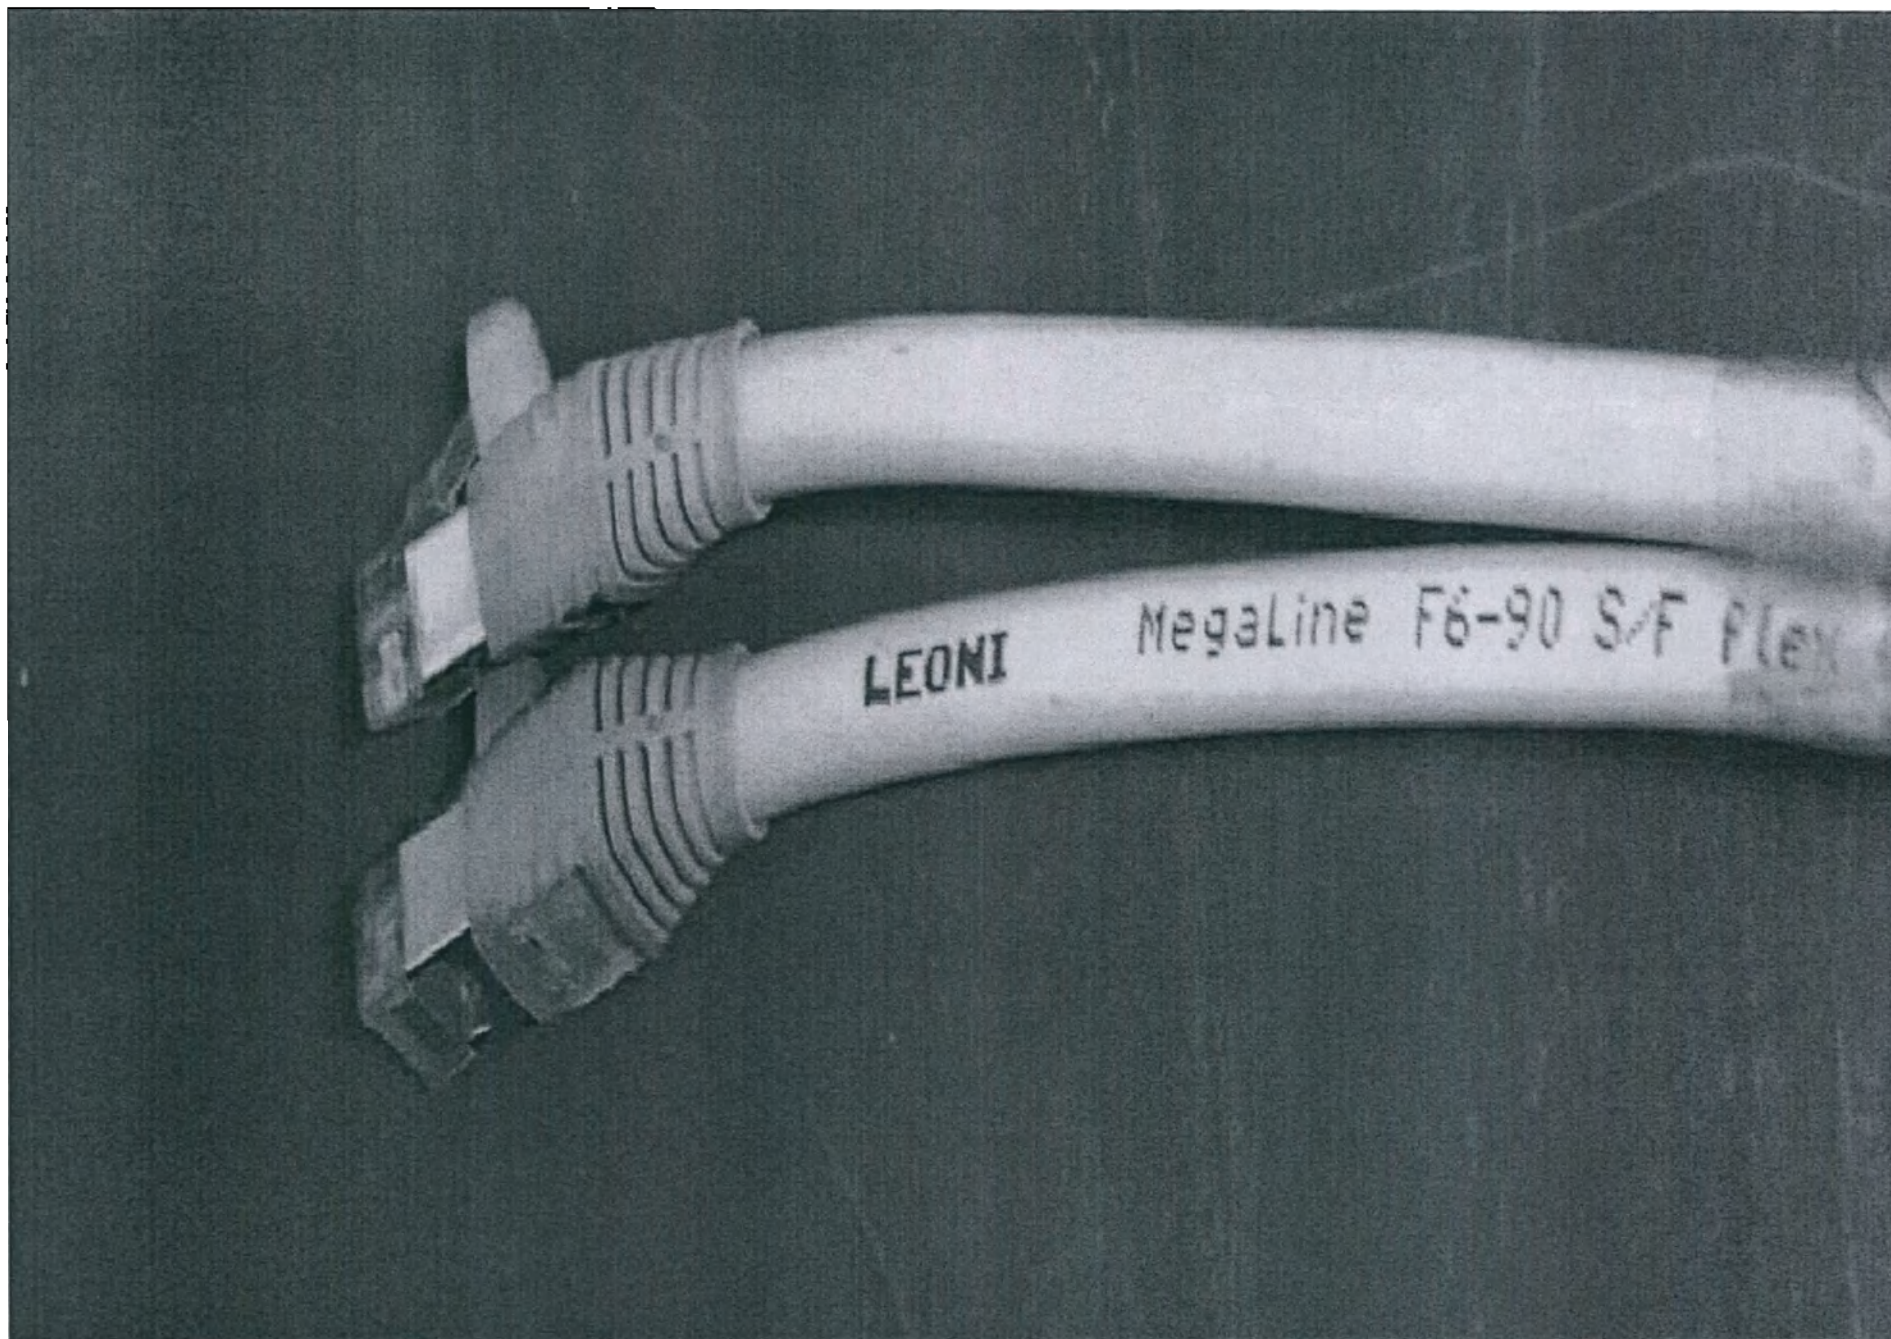

72. Кабель сетевой

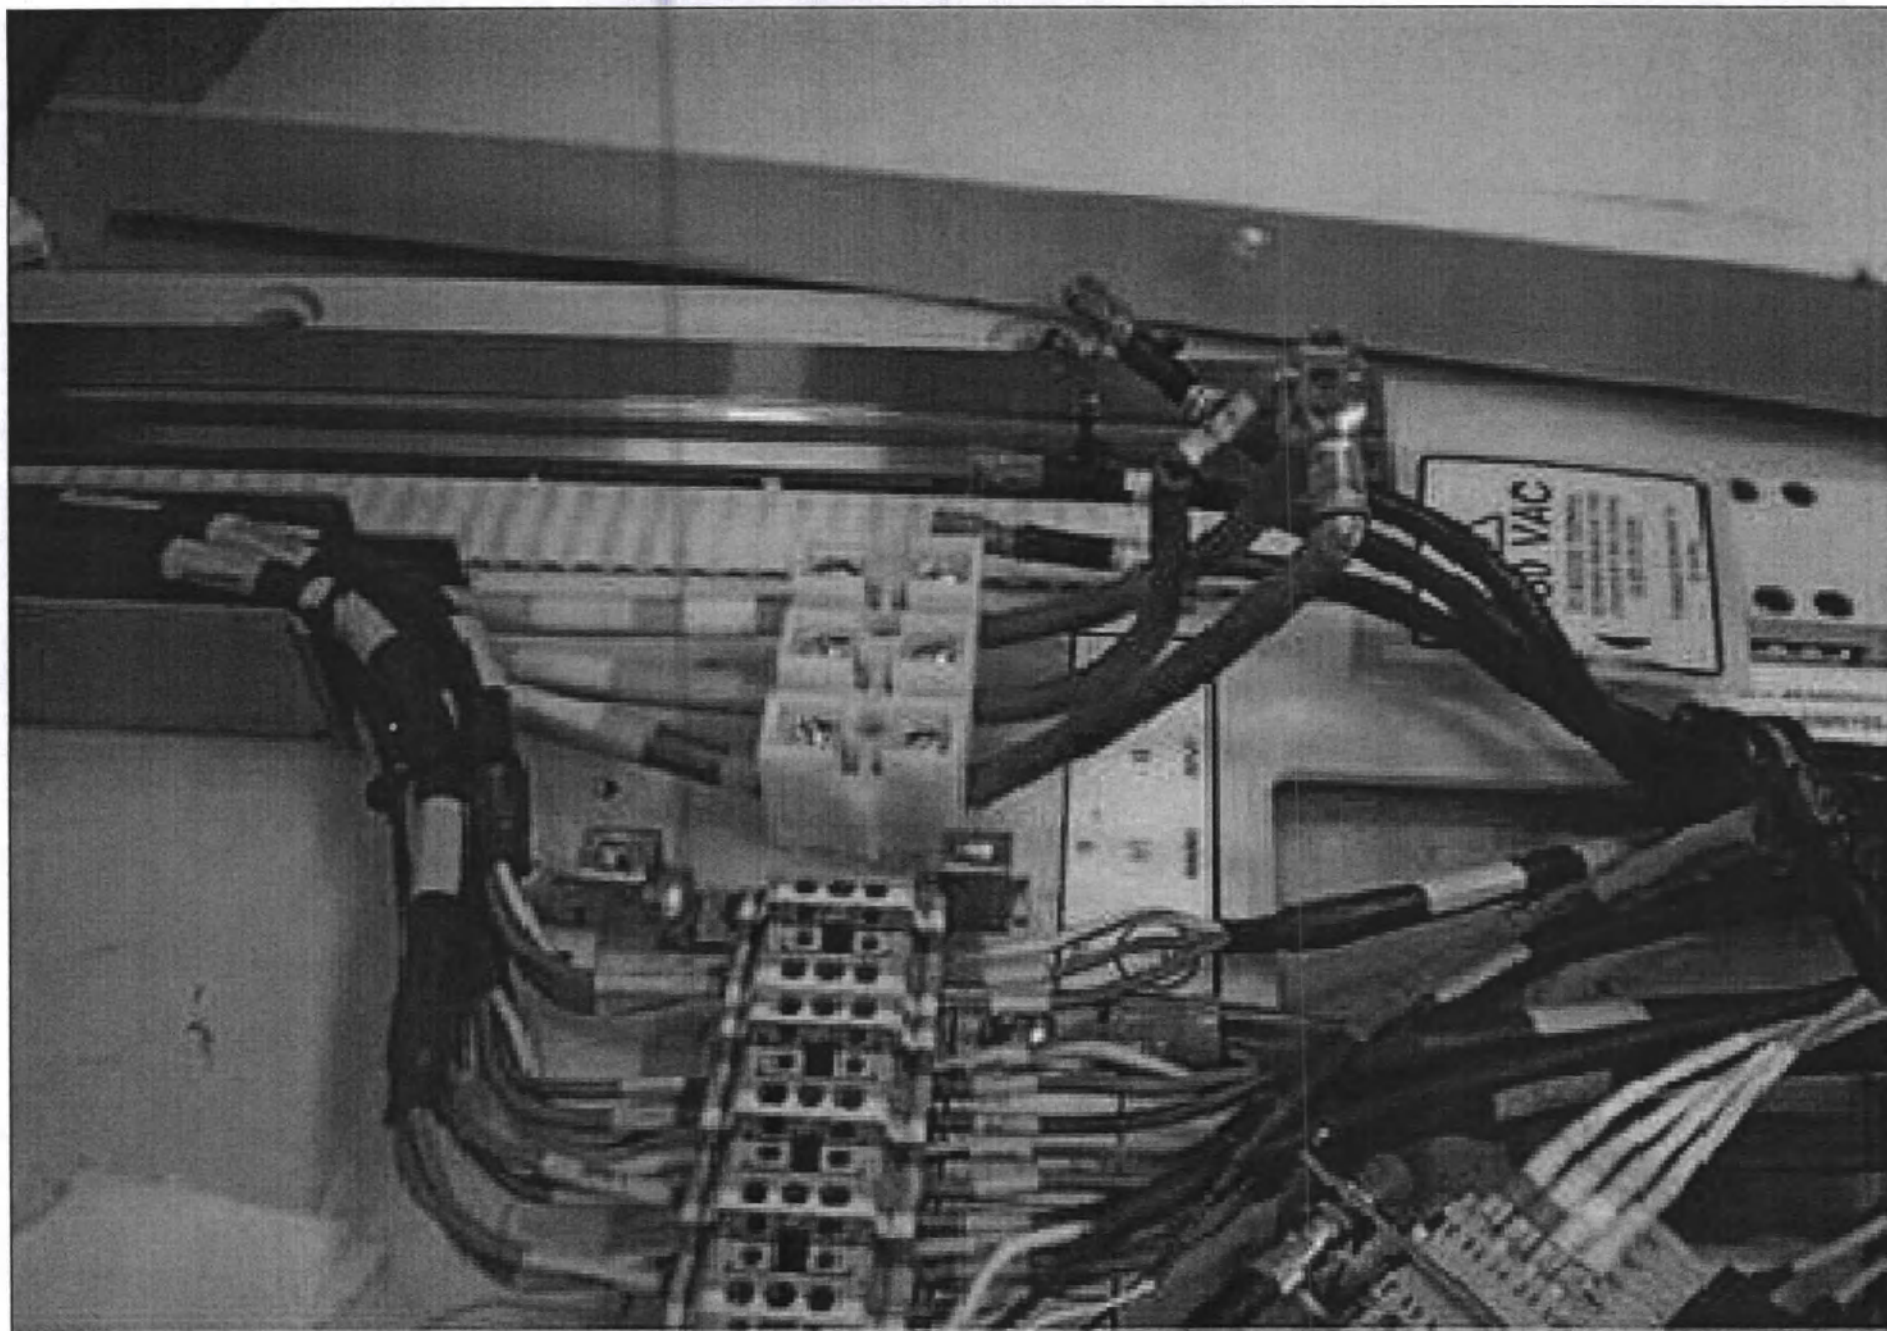

73. Разъемы для подсоединения кабеля

Маркировка:

Производитель: /производитель в соответствии с РУ/
 /адрес производителя по РУ/
Место производства: /наименование и адрес места производства по РУ/

Медицинское Изделие:
 /наименование по РУ/

Вариант исполнения: /вариант исполнения по РУ/

Предупреждения: см. 

Номинальный режим работы: см. 


Серийный номер:
 Информация доступна на основном лейбле

Дата производства:
 Информация доступна на основном лейбле


Регистрационное удостоверение:
 № РЗН 2018/7035


Макет русскоязычной маркировки систем ангиографических Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20

Упаковка:

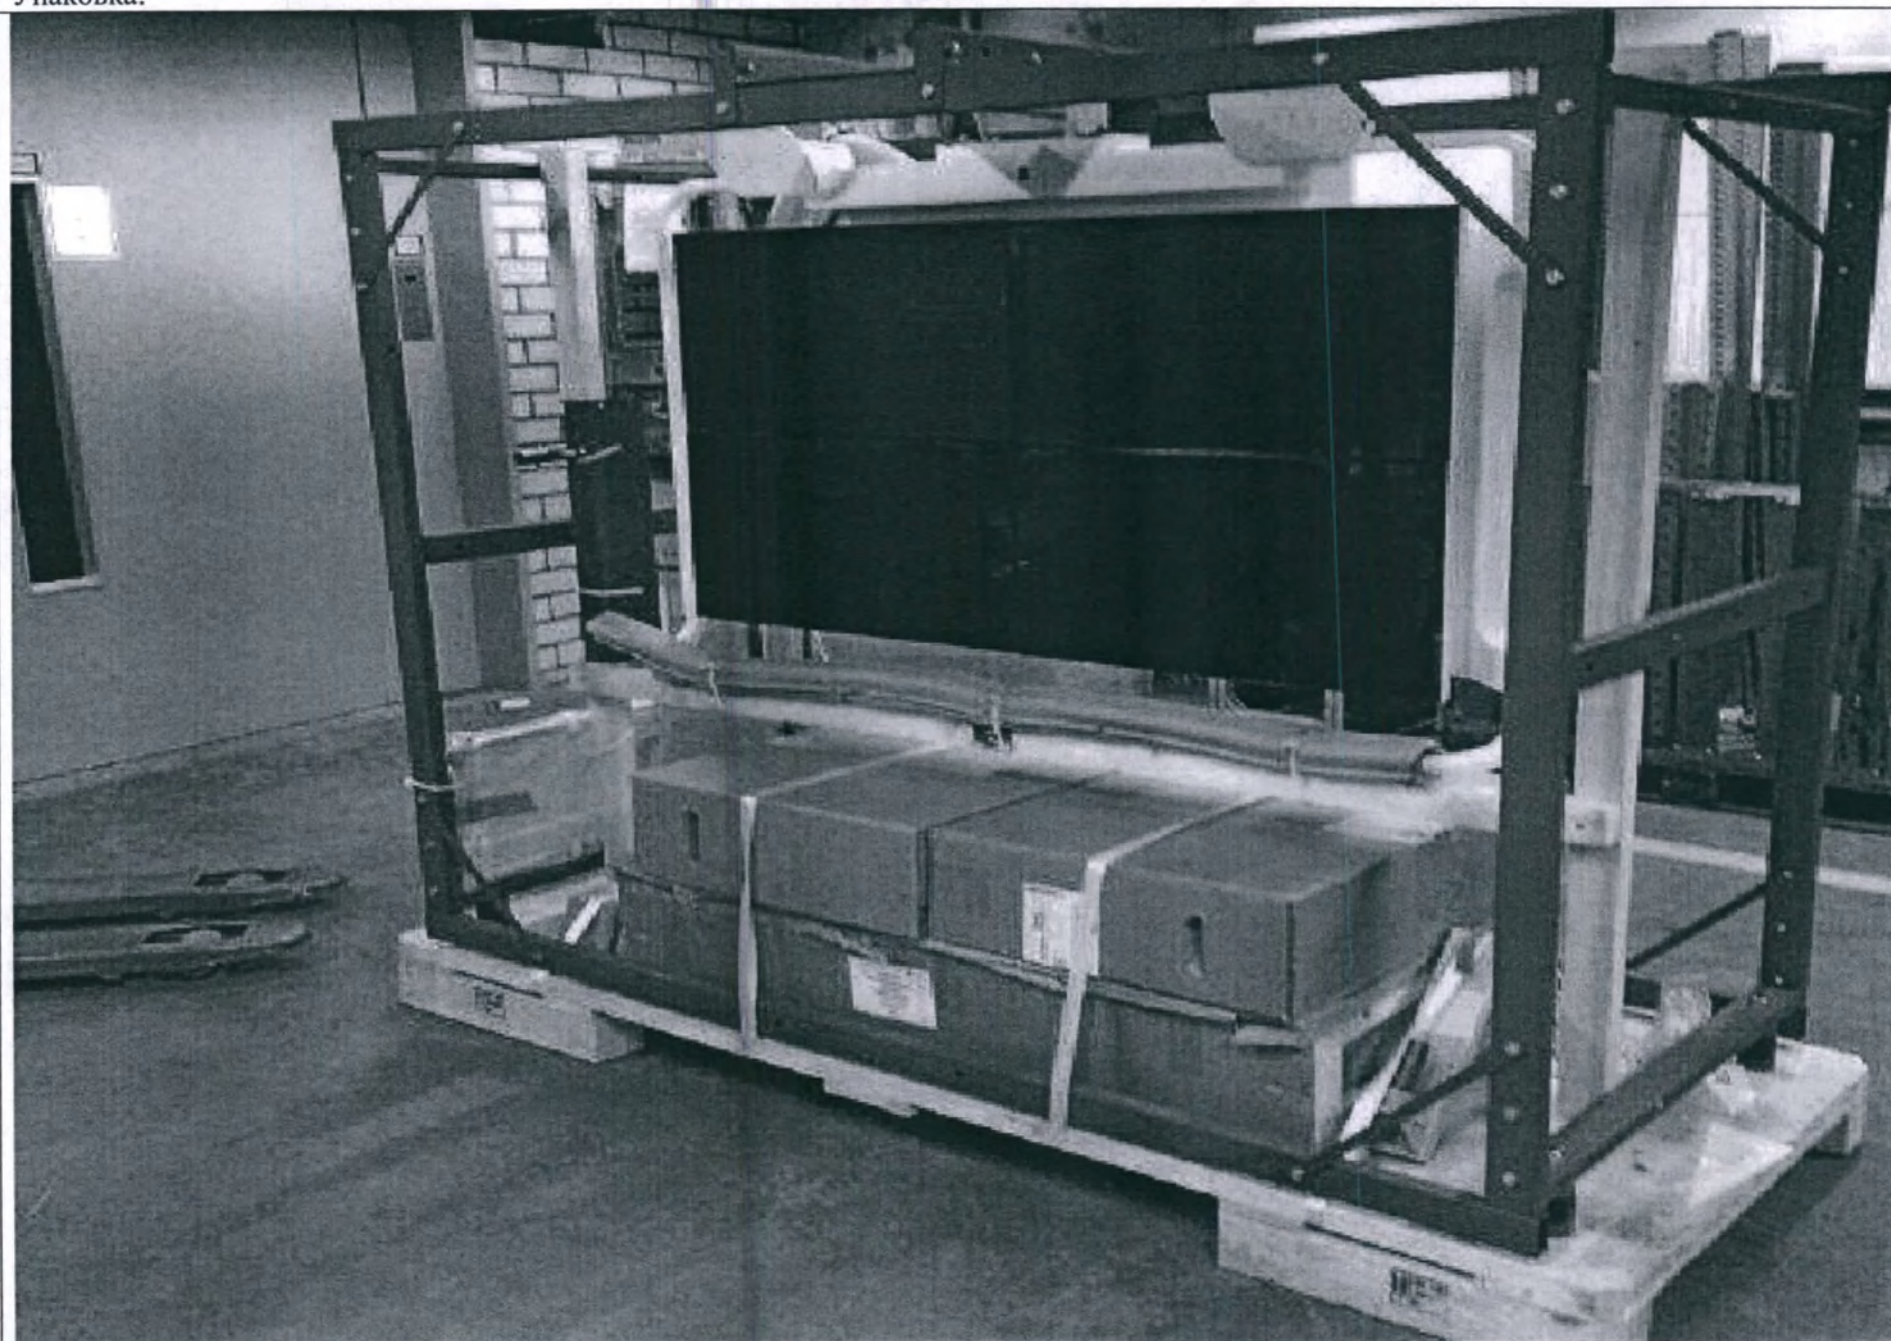

Потолочный подвес для мониторов установленный на специальный стенд для транспортировки.

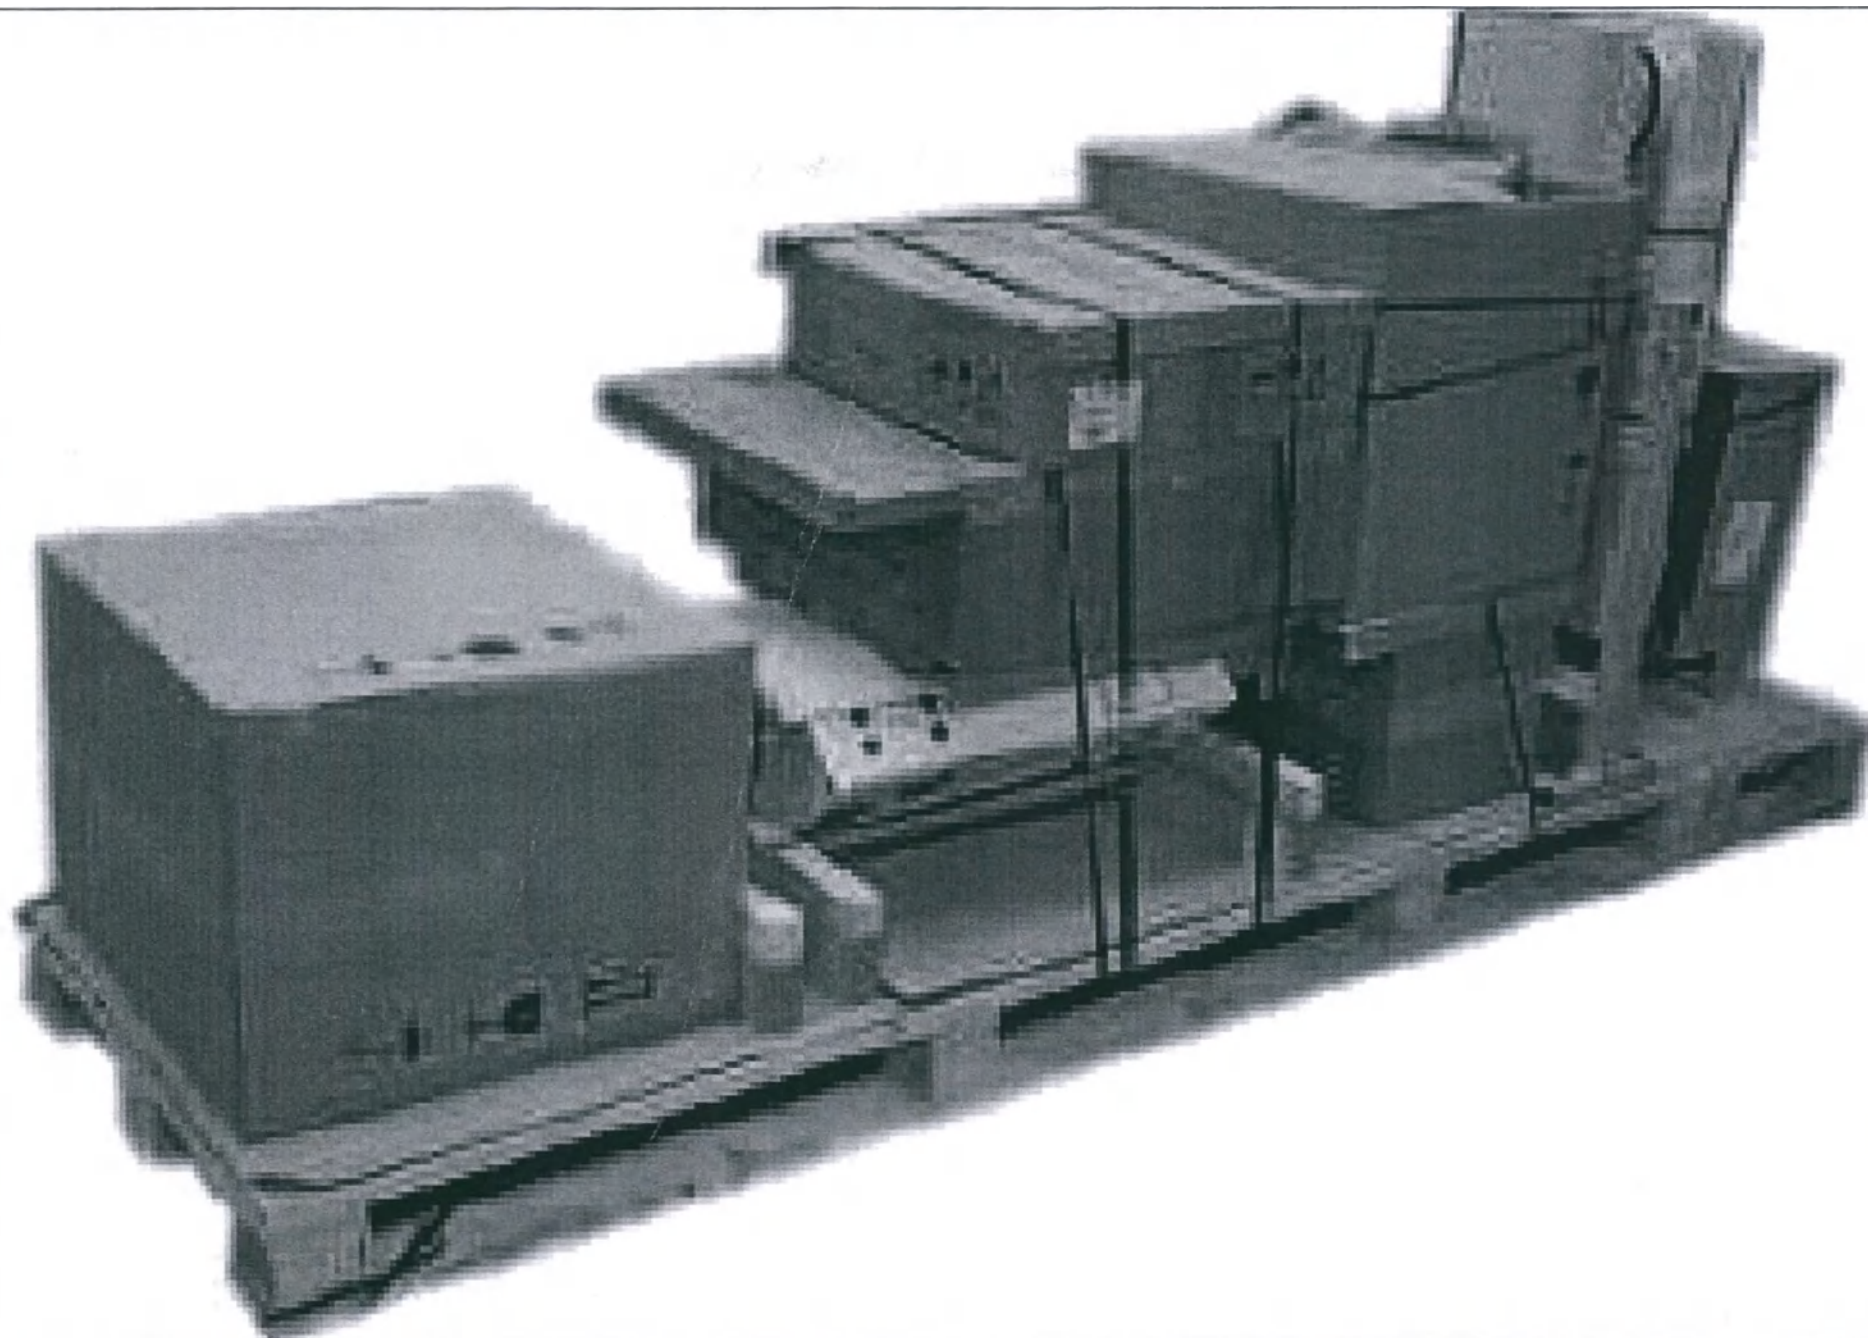

Упакованные компоненты системы

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
355 листа (св)

