

Фотографические изображения медицинского изделия:
Устройство для фиксации катетера StatLock, варианты исполнения

Устройство для фиксации катетера StatLock, варианты исполнения:

1. Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения Univ Plus Small 6-8,5 Fr, в составе:

- ретейнер с малым зажимом на универсальной подушечке – 1 шт.

- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.

Устройство для фиксации катетера
StatLock, вариант исполнения

Univ Plus Small 6-8,5 Fr

Состав:

- ретейнер с малым зажимом на универсальной подушечке – 1 шт.
- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.

REF	Номер по каталогу	VUPD68CE
LOT	Код партии	JUYJF085
	Использовать до...	2017-10

Rx only

Для использования
только специалистами



Обратитесь к инструкции
по применению

Не содержит натуральный латекс




Не использовать при
поврежденной упаковке



Не стерилизовать повторно



Не использовать
повторно



Температурный диапазон




Стерилизация с
применением окиси
этилена



Производитель: "Bard Access Systems, Inc.", 605 North
5600 West Salt Lake City, Utah, 84116 USA


CE
0086

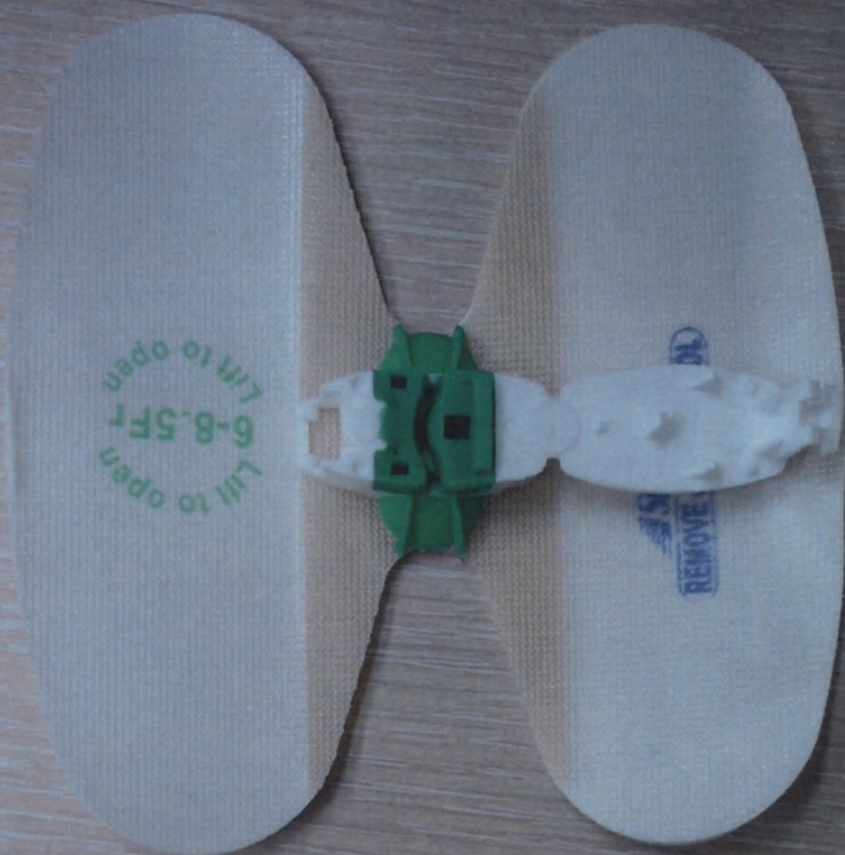


Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения Univ Plus Lg 12-14 Fr, в составе:

ретенер с большим зажимом на универсальной подушечке – 1 шт.


подушечка для подготовки кожи – 1 шт.

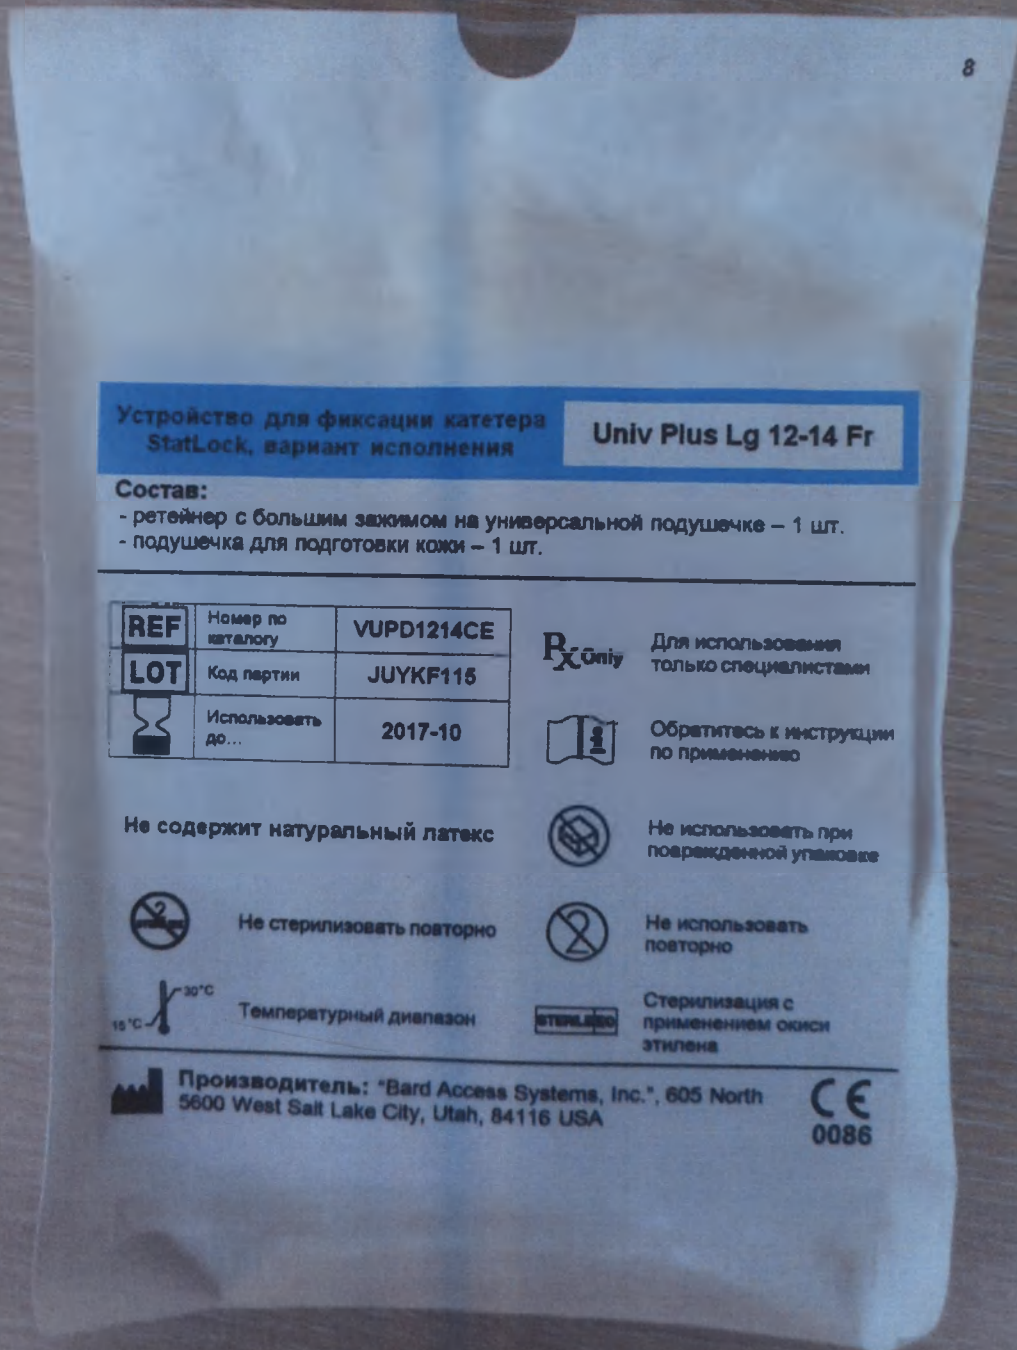

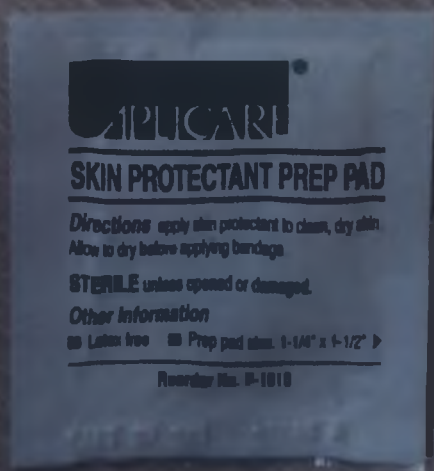

3. Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения Univ Plus Med. 10-12 Fr, в составе:

- ретейнер со средним зажимом на универсальной подушечке – 1 шт.
- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.

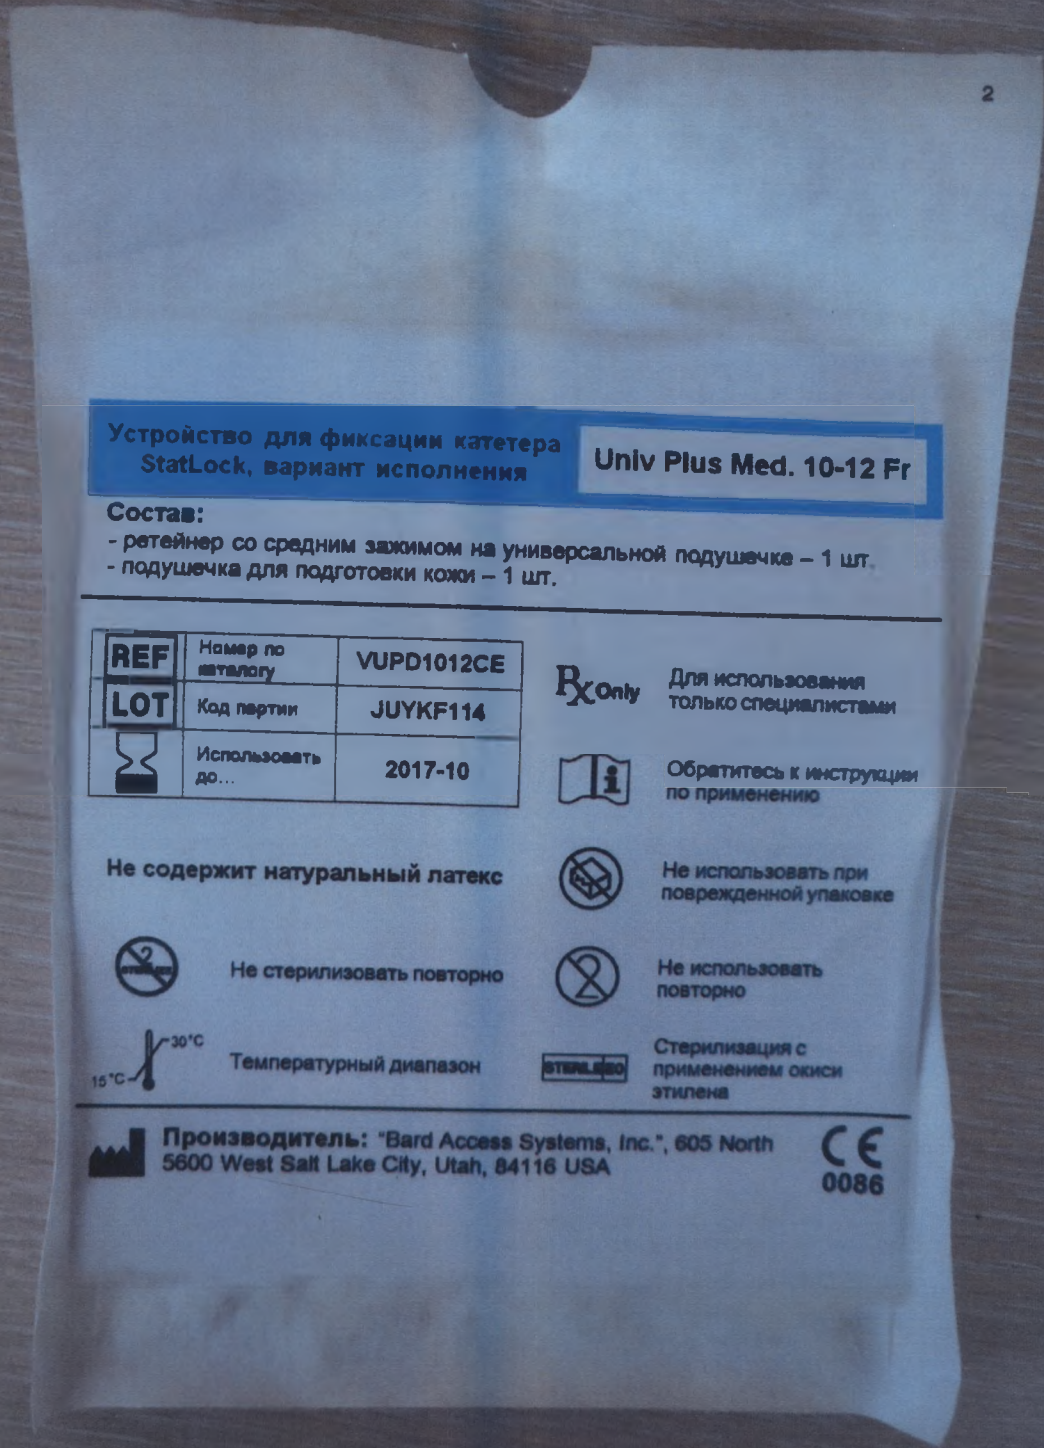



4. Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения IV Ultra, в составе:
- ретейнер с подушечками Ultra – 1 шт.
 - подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
 - клейкие полоски – 2 шт.

Устройство для фиксации катетера
StatLock, вариант исполнения

IV Ultra

Состав:

- ретейнер с подушечками Ultra – 1 шт.
- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
- клейкие полоски – 2 шт.

REF	Номер по каталогу	IV0520CE
LOT	Код партии	JUYKF107
	Использовать до...	2017-10

Rx Only

Для использования
только специалистами



Обратитесь к инструкции
по применению

Не содержит натуральный латекс




Не использовать при
поврежденной упаковке



Не стерилизовать повторно



Не использовать
повторно



Температурный диапазон



Стерилизация с
применением окиси
этилена



Производитель: "Bard Access Systems, Inc.", 605 North
5600 West Salt Lake City, Utah, 84116 USA

CE
0086



5. Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения IV Select macro 6 in (152,4 mm), в составе:

- ретейнер с подушечками Select – 1 шт.
- удлинительный узел 152,4 мм – 1 шт.
- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
- клейкие полоски – 2 шт.

Устройство для фиксации катетера
StatLock, вариант исполнения

IV Select macro 6 in
(152,4 mm)

Состав:

- ретейнер с подушечками Select – 1 шт.
- удлинительный узел 152,4 мм – 1 шт.
- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
- клейкие полоски – 2 шт.

REF	Номер по каталогу	IV0525CE	Rx Only	Для использования только специалистами
LOT	Код партии	JUYBF412		
	Использовать до...	2017-02		

Не содержит натуральный латекс

Не использовать повторно

Не использовать при поврежденной упаковке

Не использовать повторно

Температурный диапазон

Стерилизация с применением окиси этилена

Производитель: "Bard Access Systems, Inc.", 605 North 5600 West Salt Lake City, Utah, 84116 USA

CE 0086



6. Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения PICC Plus cresc sld-post, в составе:
- ретейнер со скользящим зажимом и серповидной подушечкой – 1 шт.
 - подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
 - клейкая полоска – 1 шт.



Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения

PICC Plus cresc sld-post

- Состав:
- ретейнер со скользящим зажимом и серповидной подушечкой – 1 шт.
 - подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
 - клейкая полоска – 1 шт.

REF	Номер по каталогу	VPPCSPCE
LOT	Код партии	JUYJF454
	Использовать до...	2017-10

- Rx Only
- Для использования только специалистами
-
- Обратитесь к инструкции по применению

- Не содержит натуральный латекс
- Не использовать при поврежденной упаковке
- Не стерилизовать повторно
- Не использовать повторно

- 15°C — 30°C
- Температурный диапазон
-
- Стерилизация с применением окиси этилена

Производитель: "Bard Access Systems, Inc.", 605 North 5600 West Salt Lake City, Utah, 84116 USA

CE 0086



7. Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения PICC Plus Cresc Tricot sld-post, в составе:

- ретейнер со скользящим зажимом и трикотажной серповидной подушечкой – 1 шт.
- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
- клейкая полоска – 1 шт.

Устройство для фиксации катетера
StatLock, вариант исполнения

PICC Plus Cresc Tricot
sld-post

Состав:

- ретейнер со скользящим зажимом и трикотажной серповидной подушечкой – 1 шт.
- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
- клейкая полоска – 1 шт.

REF	Номер по каталогу	PIC0220CE
LOT	Код партии	JUUYJF595
	Использовать до...	2017-10

Px Only

Для использования
только специалистами



Обратитесь к инструкции
по применению

Не содержит натуральный латекс




Не использовать при
поврежденной упаковке



Не стерилизовать повторно



Не использовать
повторно



Температурный диапазон



Стерилизация с
применением окиси
этилена



Производитель: "Bard Access Systems, Inc.", 605 North
5600 West Salt Lake City, Utah, 84116 USA

CE
0086



8. Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения CV Plus cresc tricot no pigtail, в составе:
- ретейнер со скользящим зажимом и трикотажной гидроколлоидной серповидной подушечкой – 1 шт.
 - подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
 - клейкая полоска – 1 шт.

5

Устройство для фиксации катетера
StatLock, вариант исполнения

CV Plus cresc tricot no
pigtail

Состав:

- ретейнер со скользящим зажимом и трикотажной гидроколлоидной серповидной подушечкой – 1 шт.
- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
- клейкая полоска – 1 шт.

REF	Номер по каталогу	CV0226CE
LOT	Код партии	JUYIF662
	Использовать до...	2017-09

Rx only

Для использования
только специалистами



Обратитесь к инструкции
по применению

Не содержит натуральный латекс




Не использовать при
поврежденной упаковке



Не стерилизовать повторно



Не использовать
повторно



Температурный диапазон



Стерилизация с
применением окиси
этилена



Производитель: "Bard Access Systems, Inc.", 605 North
5600 West Salt Lake City, Utah, 84116 USA

CE
0086



Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения CV Plus cresc tricot, в составе:
ретейнер со скользящим зажимом и трикотажной гидроколлоидной серповидной подушечкой – 1 шт.
подушечка «pigtail» – 1 шт.
подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
клеящие полоски – 2 шт.

Устройство для фиксации катетера
StatLock, вариант исполнения

CV Plus cresc tricot

Состав:

- ретейнер со скользящим зажимом и трикотажной гидроколлоидной серповидной подушечкой – 1 шт.
- подушечка «pigtail» – 1 шт.
- подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
- клейкие полоски – 2 шт.

REF	Номер по каталогу	CV0220CE
LOT	Код партии	JUYJF661
	Использовать до...	2017-09

Rx Only

Для использования
только специалистами



Обратитесь к инструкции
по применению

Не содержит натуральный латекс




Не использовать при
поврежденной упаковке



Не стерилизовать повторно



Не использовать
повторно



Температурный диапазон



Стерилизация с
применением окиси
этилена



Производитель: "Bard Access Systems, Inc.", 605 North
5600 West Salt Lake City, Utah, 84116 USA

CE
0086




Устройство для фиксации катетера StatLock, вариант исполнения Dialysis btrfly tricot hydrcld, в
таве:
тейнер на трикотажной гидроколлоидной подушечке типа «бабочка» – 1 шт.
одушечка для подготовки кожи – 1 шт.
лейкие полоски – 2 шт.

Устройство для фиксации катетера
StatLock, вариант исполнения

Dialysis btrfly tricot
hydrcld

- Состав:**
- ретейнер на трикотажной гидроколлоидной подушечке типа «бабочка» – 1 шт.
 - подушечка для подготовки кожи – 1 шт.
 - клейкие полоски – 2 шт.

REF	Номер по каталогу	DI0120CE
LOT	Код партии	JUYHF264
	Использовать до...	2017-08

-  **Rx Only** Для использования только специалистами
-  Обратитесь к инструкции по применению

- Не содержит натуральный латекс
-  Не стерилизовать повторно
-  Не использовать при поврежденной упаковке
-  Не использовать повторно
-  Температурный диапазон 15 °C - 30 °C
-  Стерилизация с применением окиси этилена

 **Производитель:** "Bard Access Systems, Inc.", 605 North 5600 West Salt Lake City, Utah, 84116 USA

CE
0086



Настоящий документ является
личной собственностью
государственного учреждения
Здравоохранения
и должен храниться в нем.

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

21 (двадцать две) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Бард Рус»

О.Н. Веков

