

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «СП.ГЕЛПИК»

В.В.Аврамов

«13»

2022 г.



Фотографии медицинского изделия:

**«Аппарат флюорографический цифровой «РЕНЕКС-ФЦМ»
по ТУ 26.60.11-057-54839165-2021»**

2022 г.

Список фотографий

на медицинское изделие: «Аппарат флюорографический цифровой «РЕНЕКС-ФЦМ»
по ТУ 26.60.11-057-54839165-2021»

- Рис 1. - Общий вид исполнение 1
- Рис 2. - Общий вид исполнение 2
- Рис 3. - Штатив рентгеновский ЛЖКМ.943129.050
- Рис 4. - Штатив рентгеновский ЛЖКМ.943129.051
- Рис 5. - Рентгеновское питающее устройством ЛЖКМ.943129.069
- Рис 6. - Рентгеновский излучатель моноблочного типа ЛЖКМ.433251.002
- Рис 7. - Коллиматор серии R
- Рис 8. - Коллиматор модель FA38
- Рис 9. - Коллиматор модель M38
- Рис 10. - Пульт управления перемещением штатива ЛЖКМ.943129.070
- Рис 11. - Пульт управления перемещением штатива ЛЖКМ.943129.071
- Рис 12. - Кабель сетевой
- Рис 13. - Устройство рентгенографическое цифровое УРЦ-М-«РЕНЕКС» по ТУ 9442-032-54839165-2011
- Рис 14. - АРМ рентгенолаборанта ЛЖКМ.466216.001
- Рис 15. - Объединенное АРМ ЛЖКМ.466216.004
- Рис 16. - АРМ врача-рентгенолога ЛЖКМ.466216.002
- Рис 17. - Комплекс аппаратно-программный
- Рис 18. - Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012
- Рис 19. - Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDAP System
- Рис 20. - Выносная кнопка экспозиции
- Рис 21. - Стол-каталка ЛЖКМ.943129.060
- Рис 22. - Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями, РУ №ФСЗ 2012/12920,
- Рис 23. - камера мультиформатная термографическая с принадлежностями Drystar AXYS, РУ № ФСЗ 2008/01838,
- Рис 24. - камера мультиформатная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2008/02790,
- Рис 25. - камера мультиформатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2008/02792,
- Рис 26. - камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX 4000 исполнения DRYPIX Plus с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12949,

Рис 27. - камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, РУ № ФСЗ 2007/00692

Рис 28. - Пленка медицинская термографическая и лазерная

Рис 29. - Комплект рентгеновской одежды для пациентов и персонала

Рис 30. - Ширмы рентгенозащитные

Рис 31. - Переговорное устройство

Рис 32. - Монитор медицинский монохромный

Рис 33. - Принтер лазерный

Рис 34. - Панель управления экспозицией

Рис 35. - Система видеонаблюдения

Рис 36. - Источник бесперебойного питания

Рис 37. - Оконный блок смотровой рентгенозащитный

Рис 38. - Фото упаковки

Рис 39. - Фото маркировки

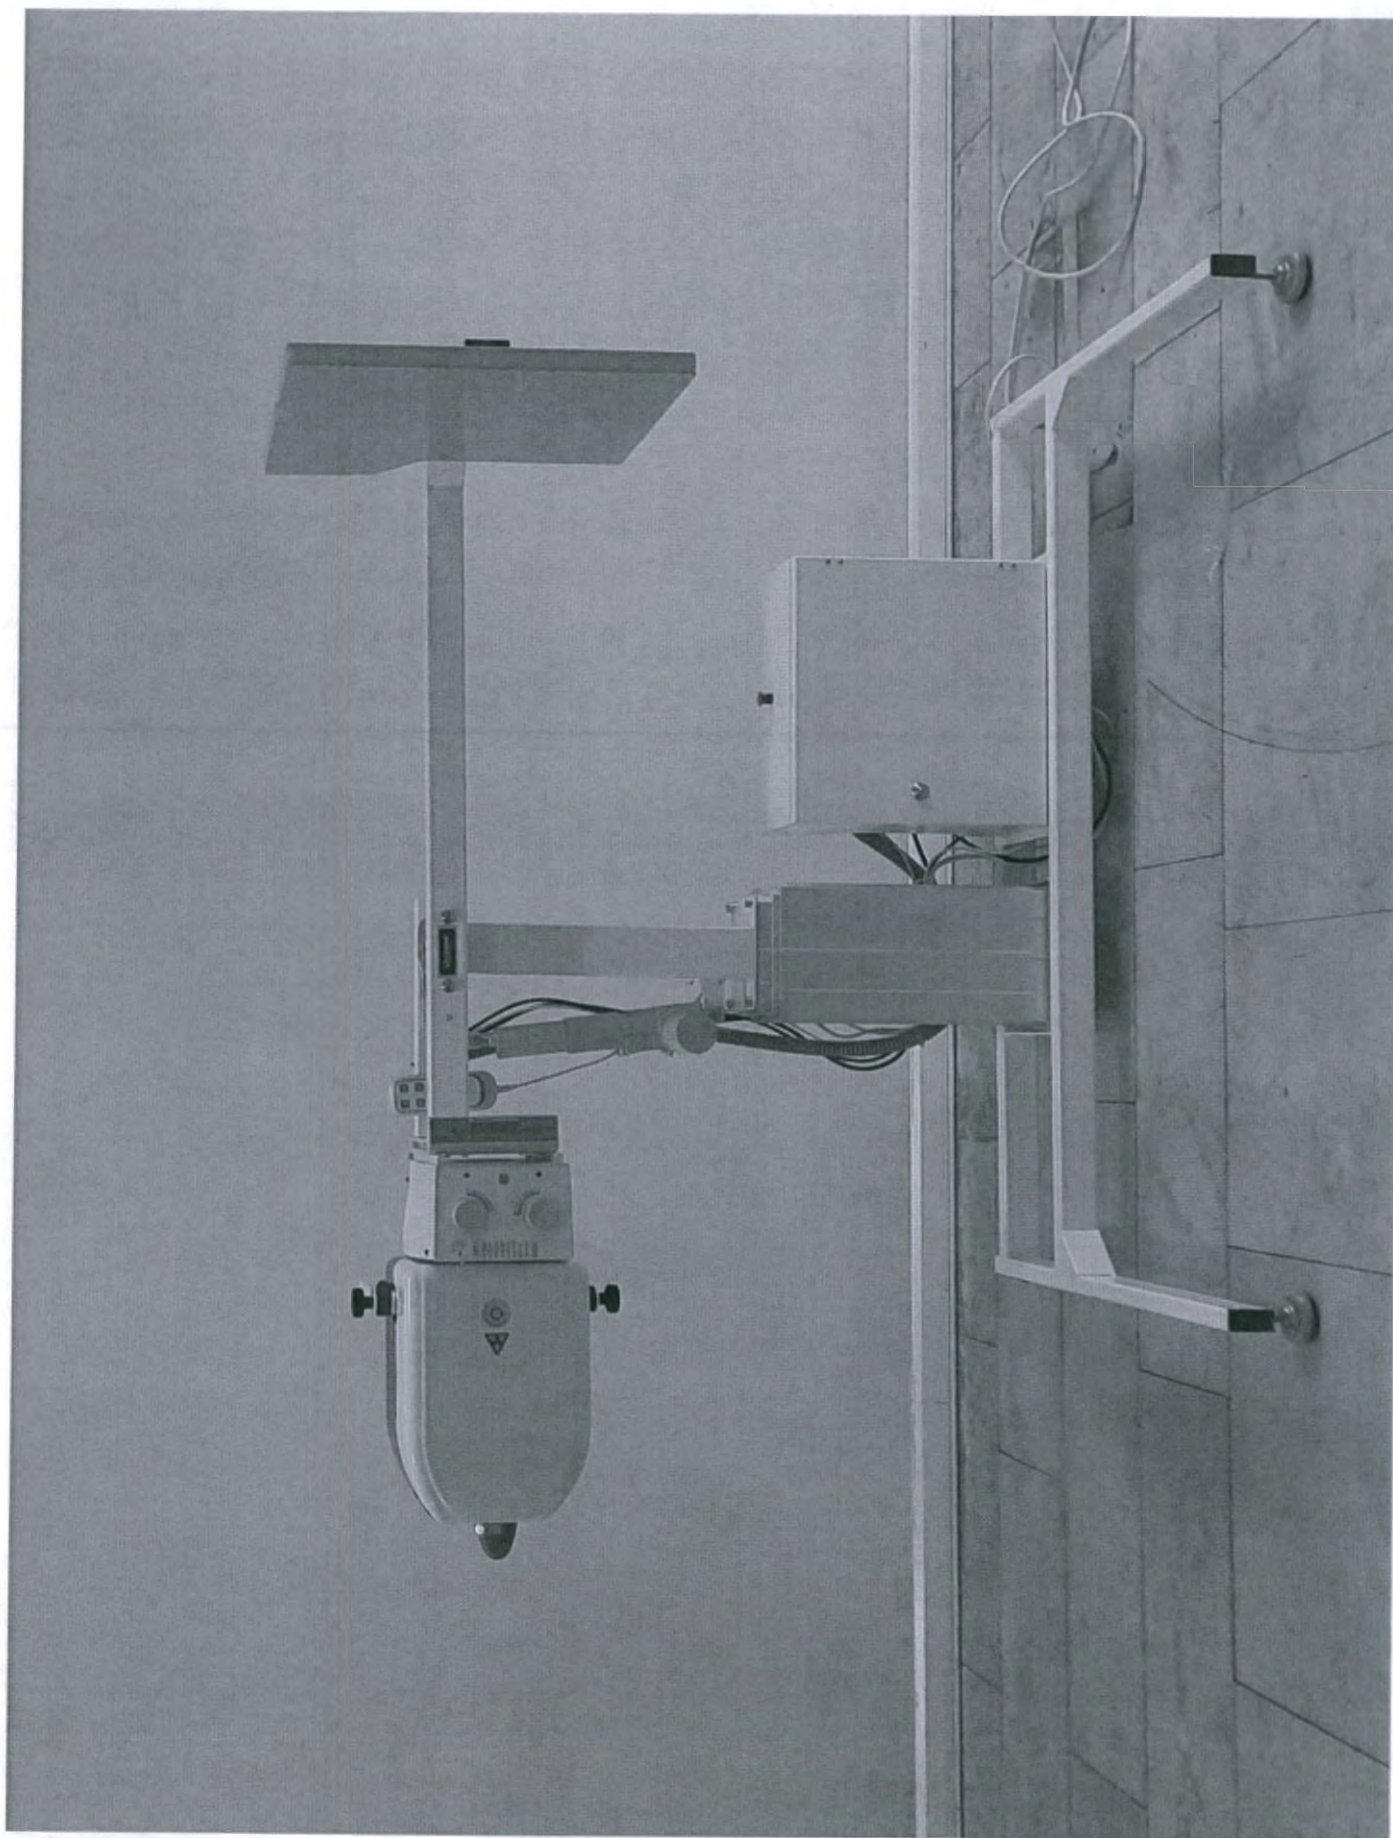


Рис 1. - Общий вид исполнение 1

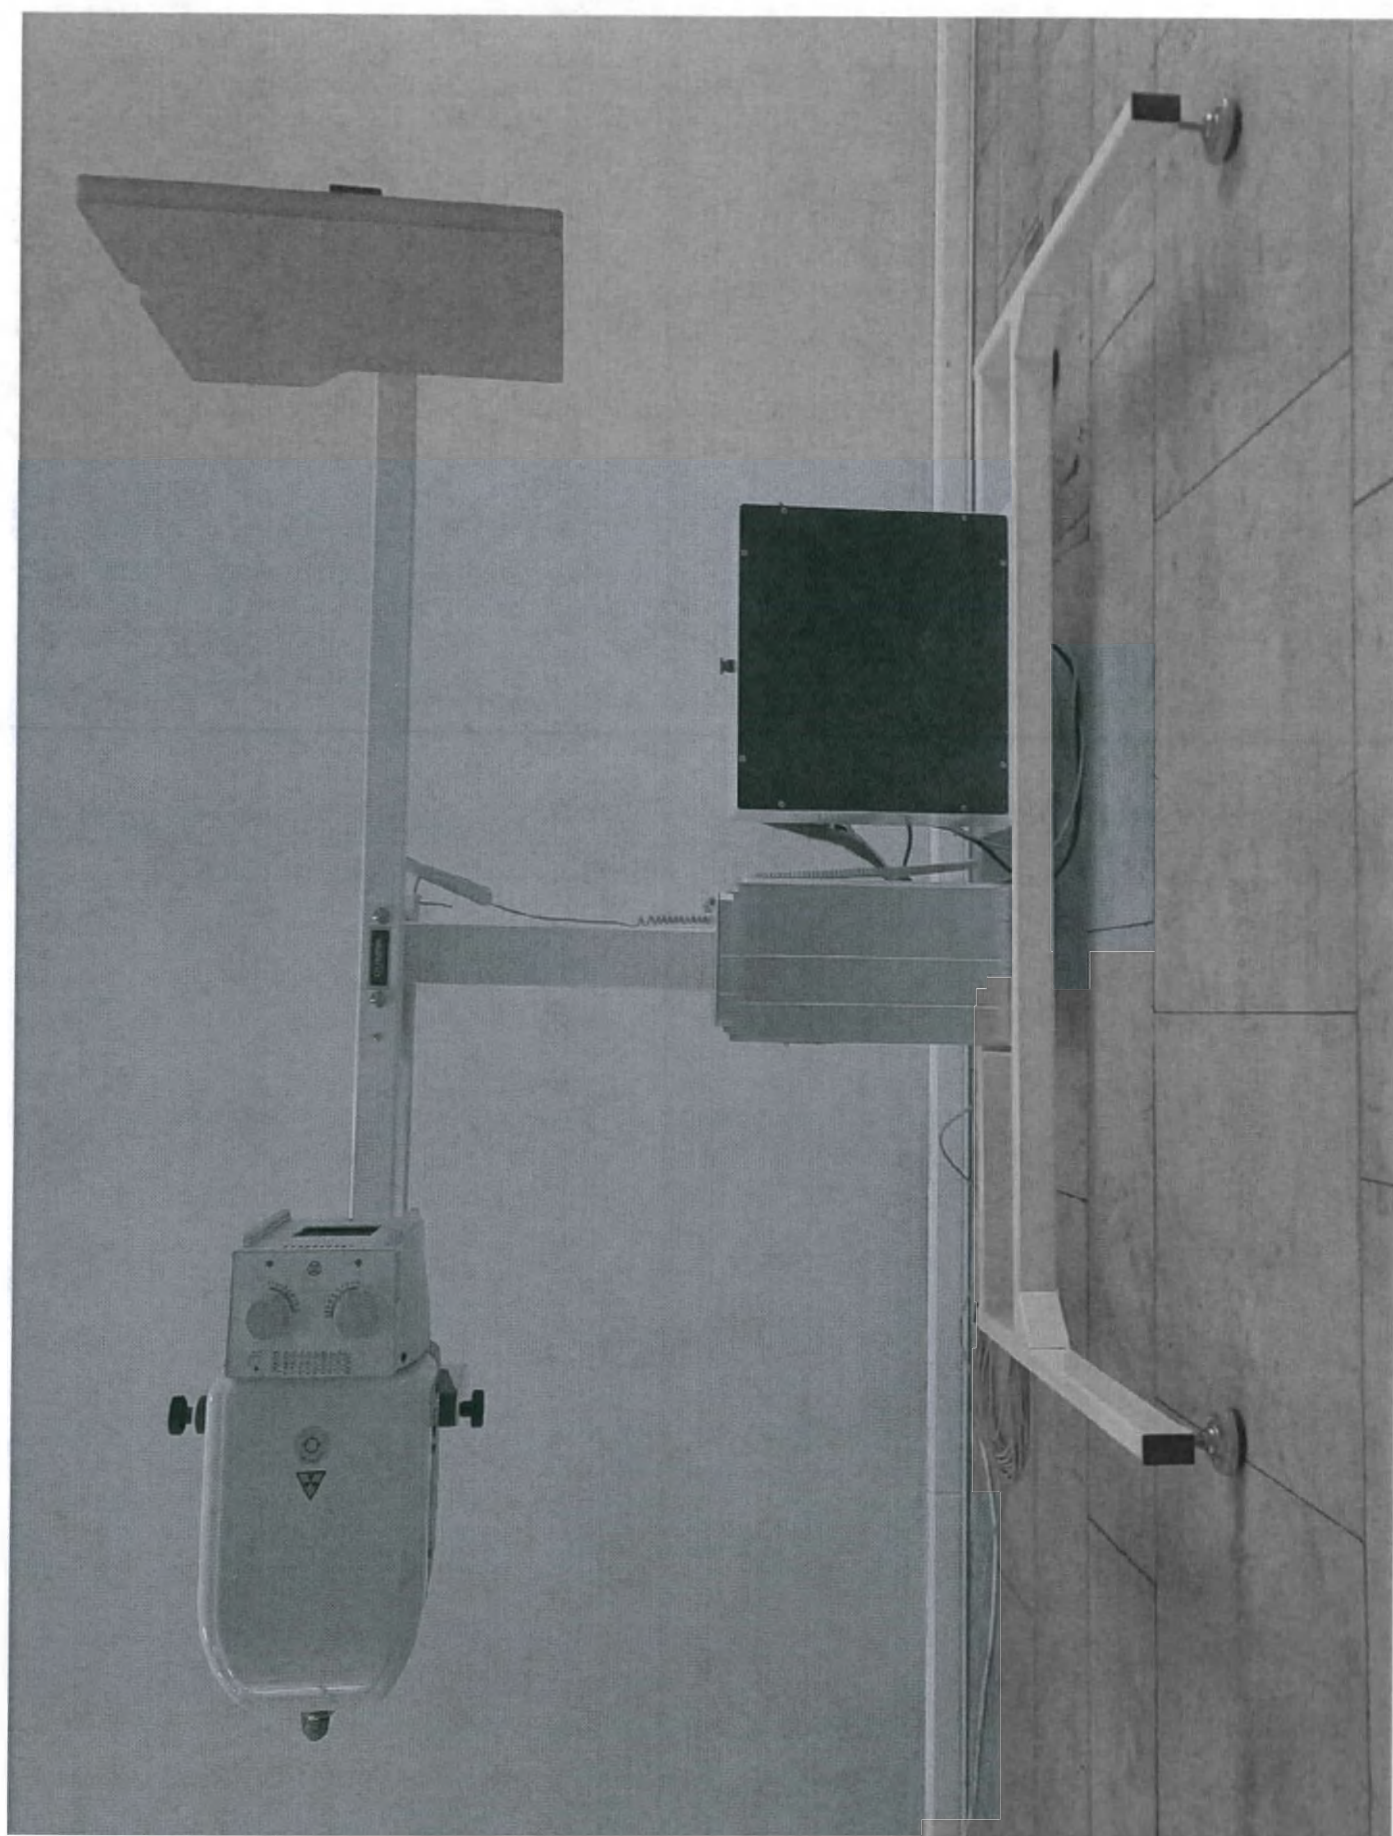


Рис 2. - Общий вид исполнение 2

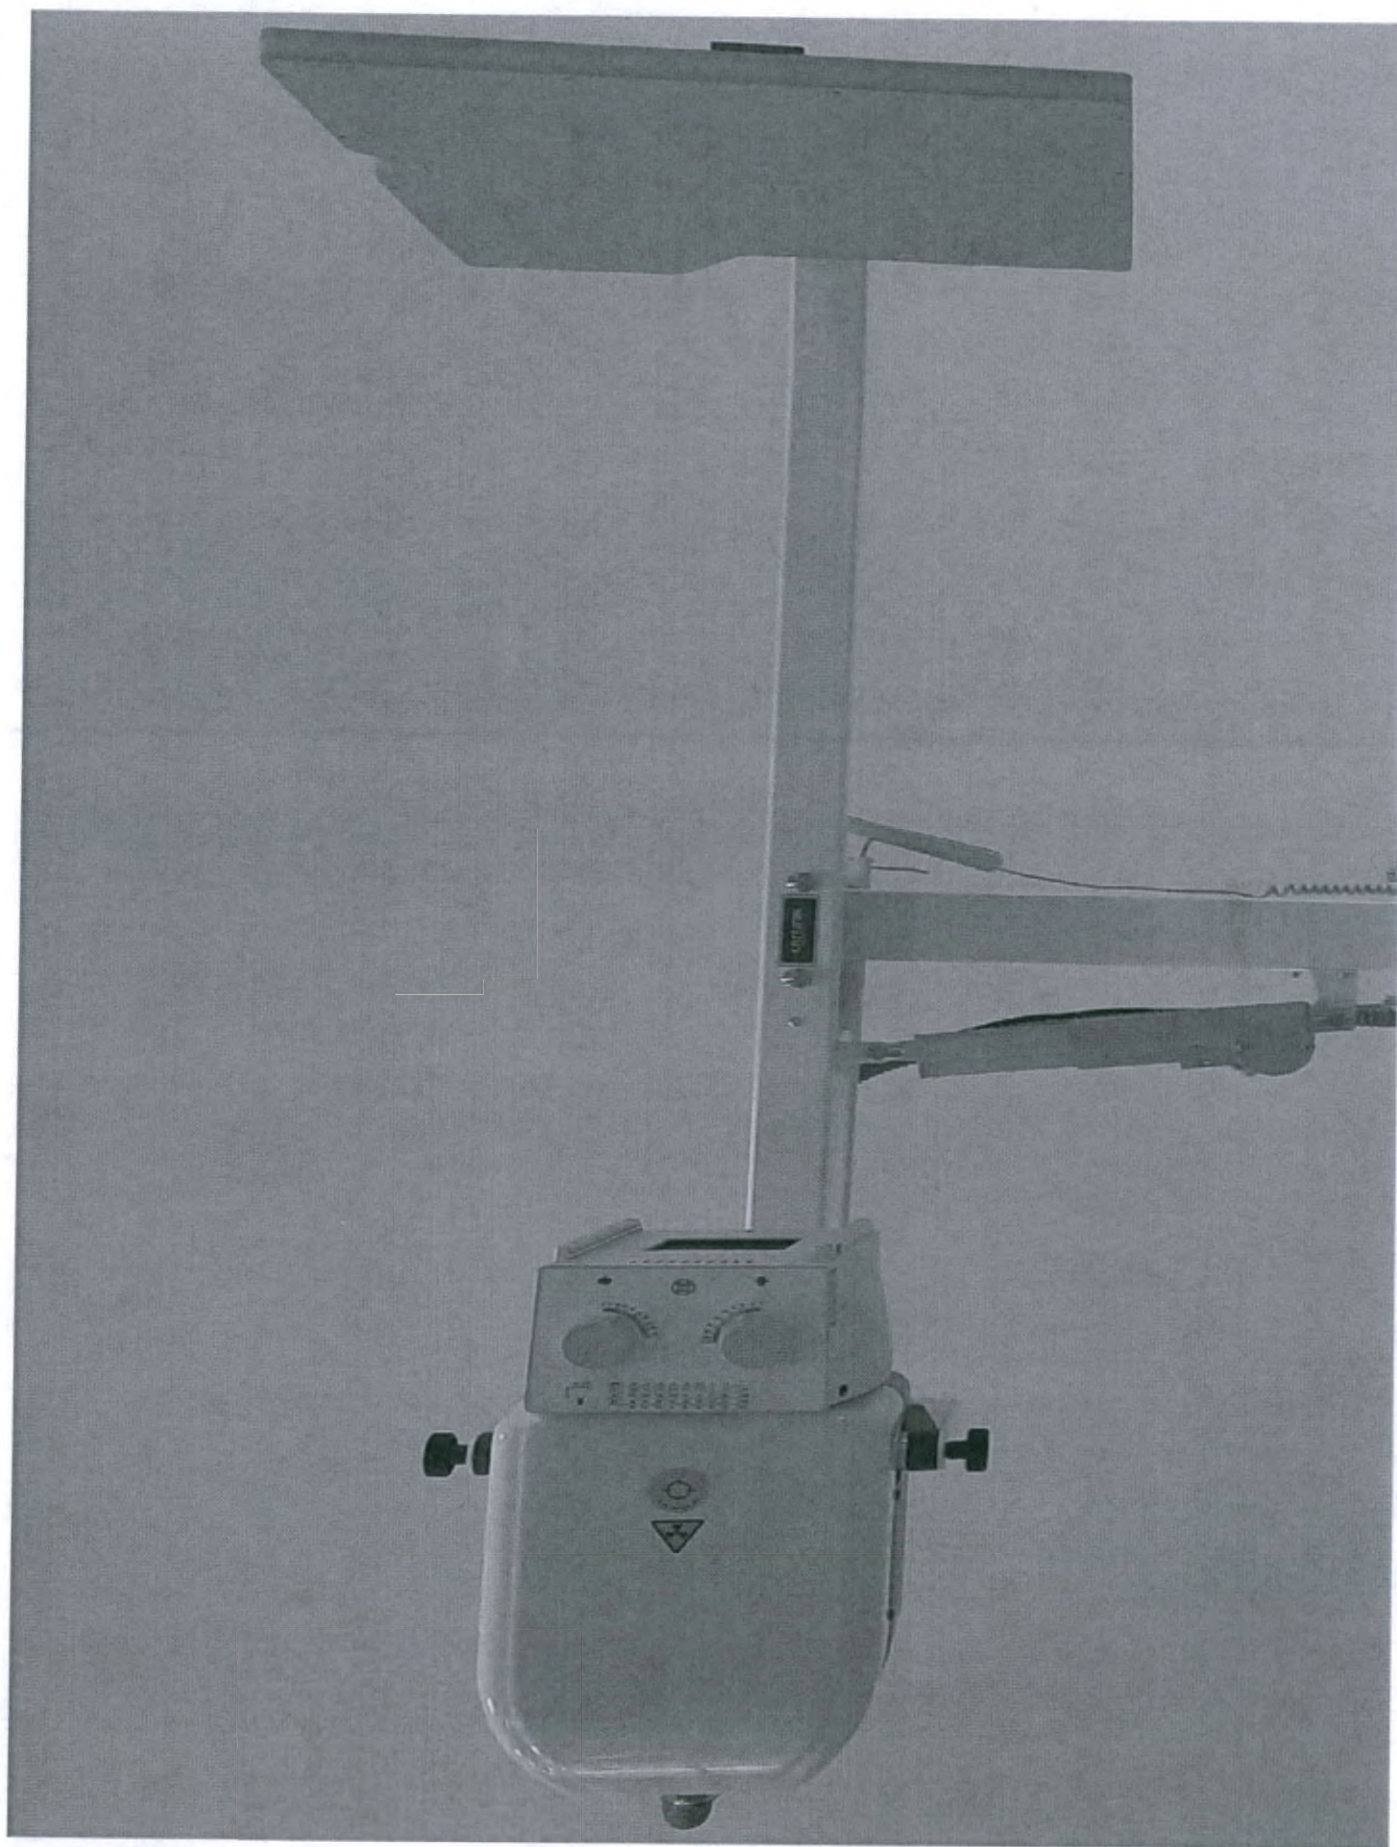


Рис 3. - Штатив рентгеновский ЛЖКМ.943129.050

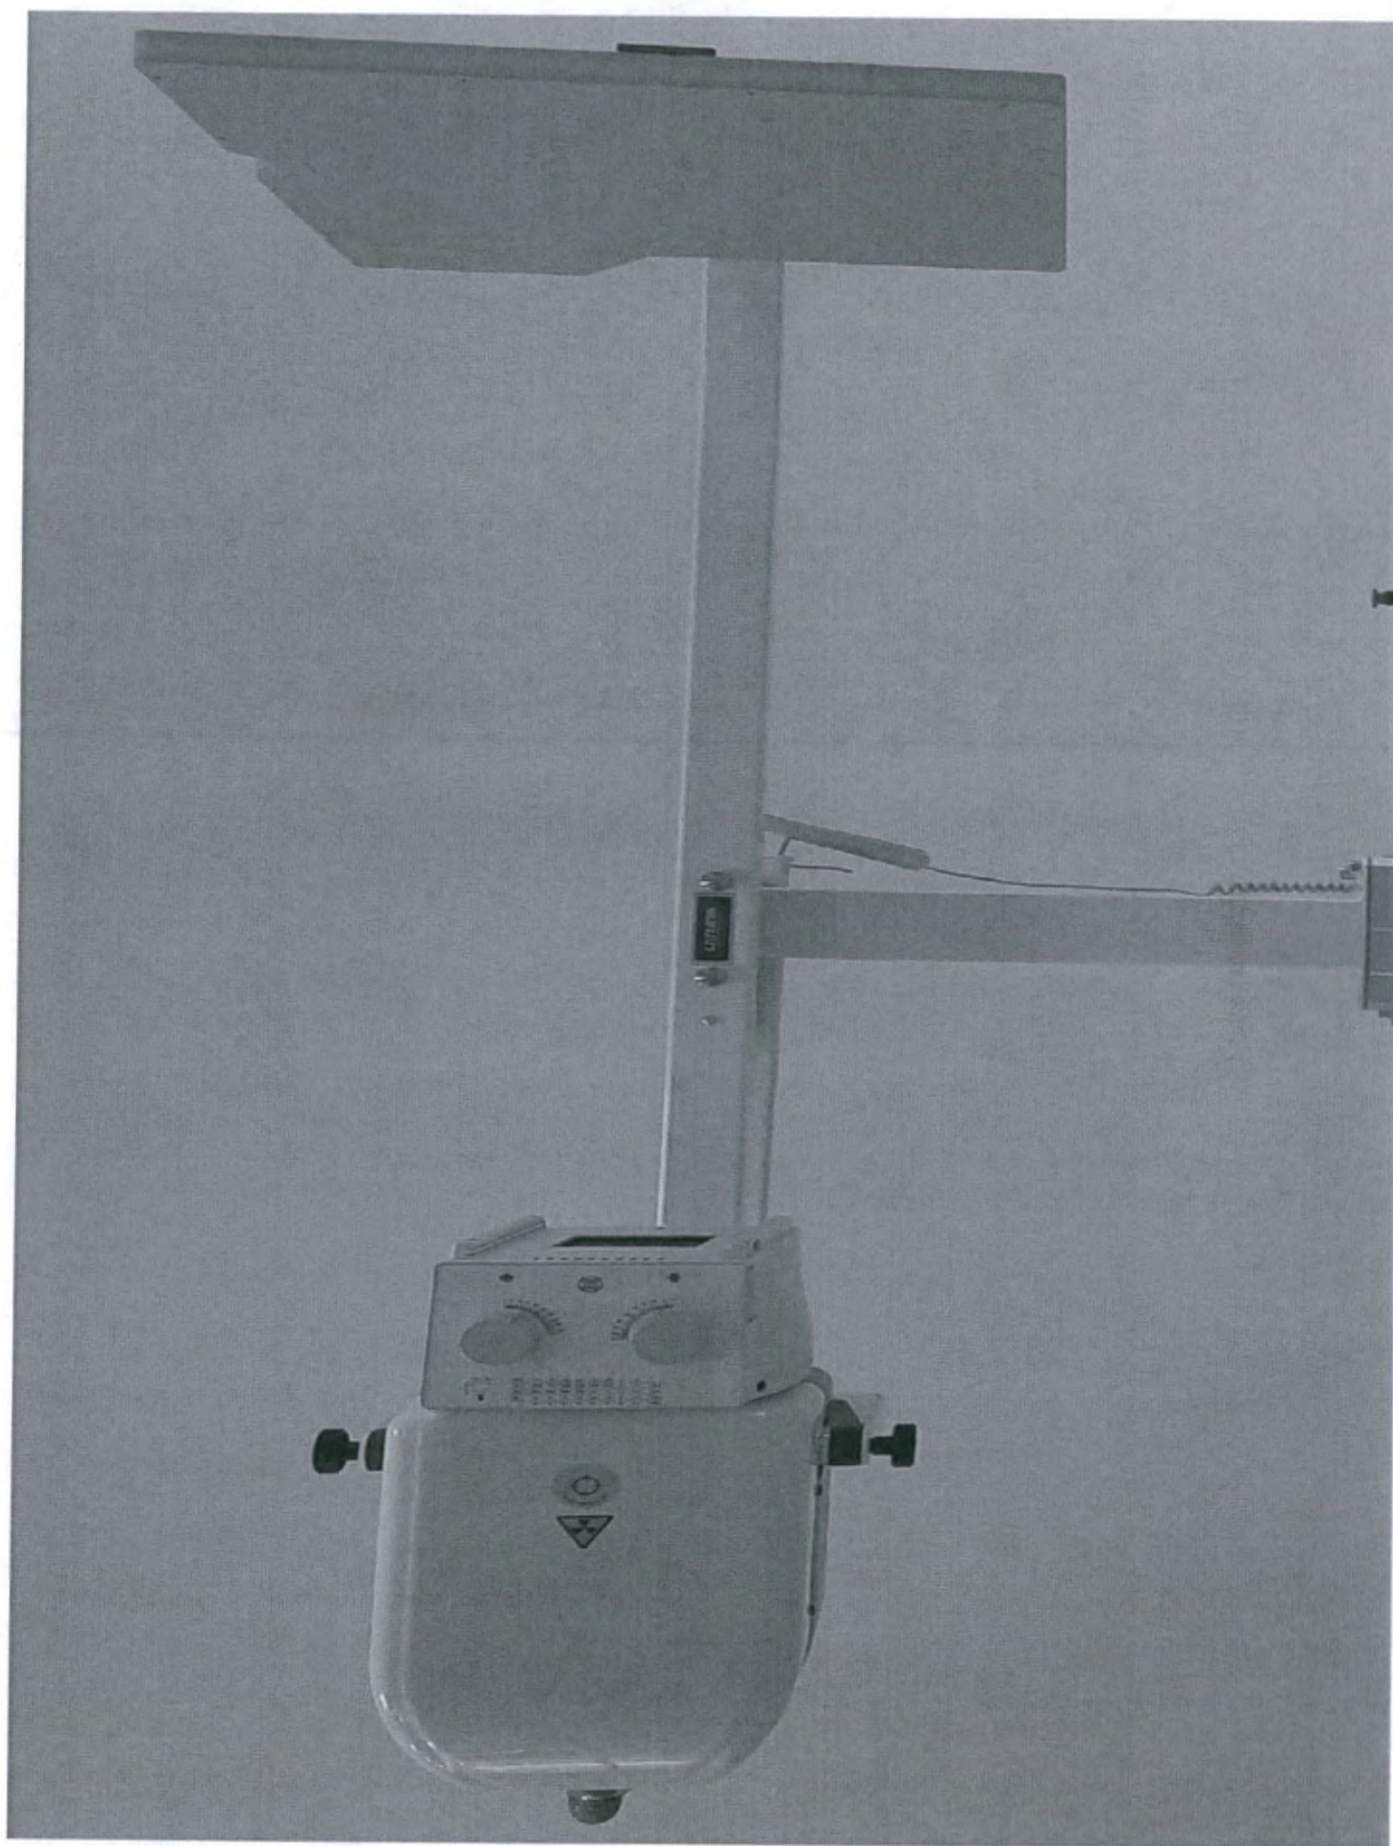


Рис 4. - Штатив рентгеновский ЛЖКМ.943129.051

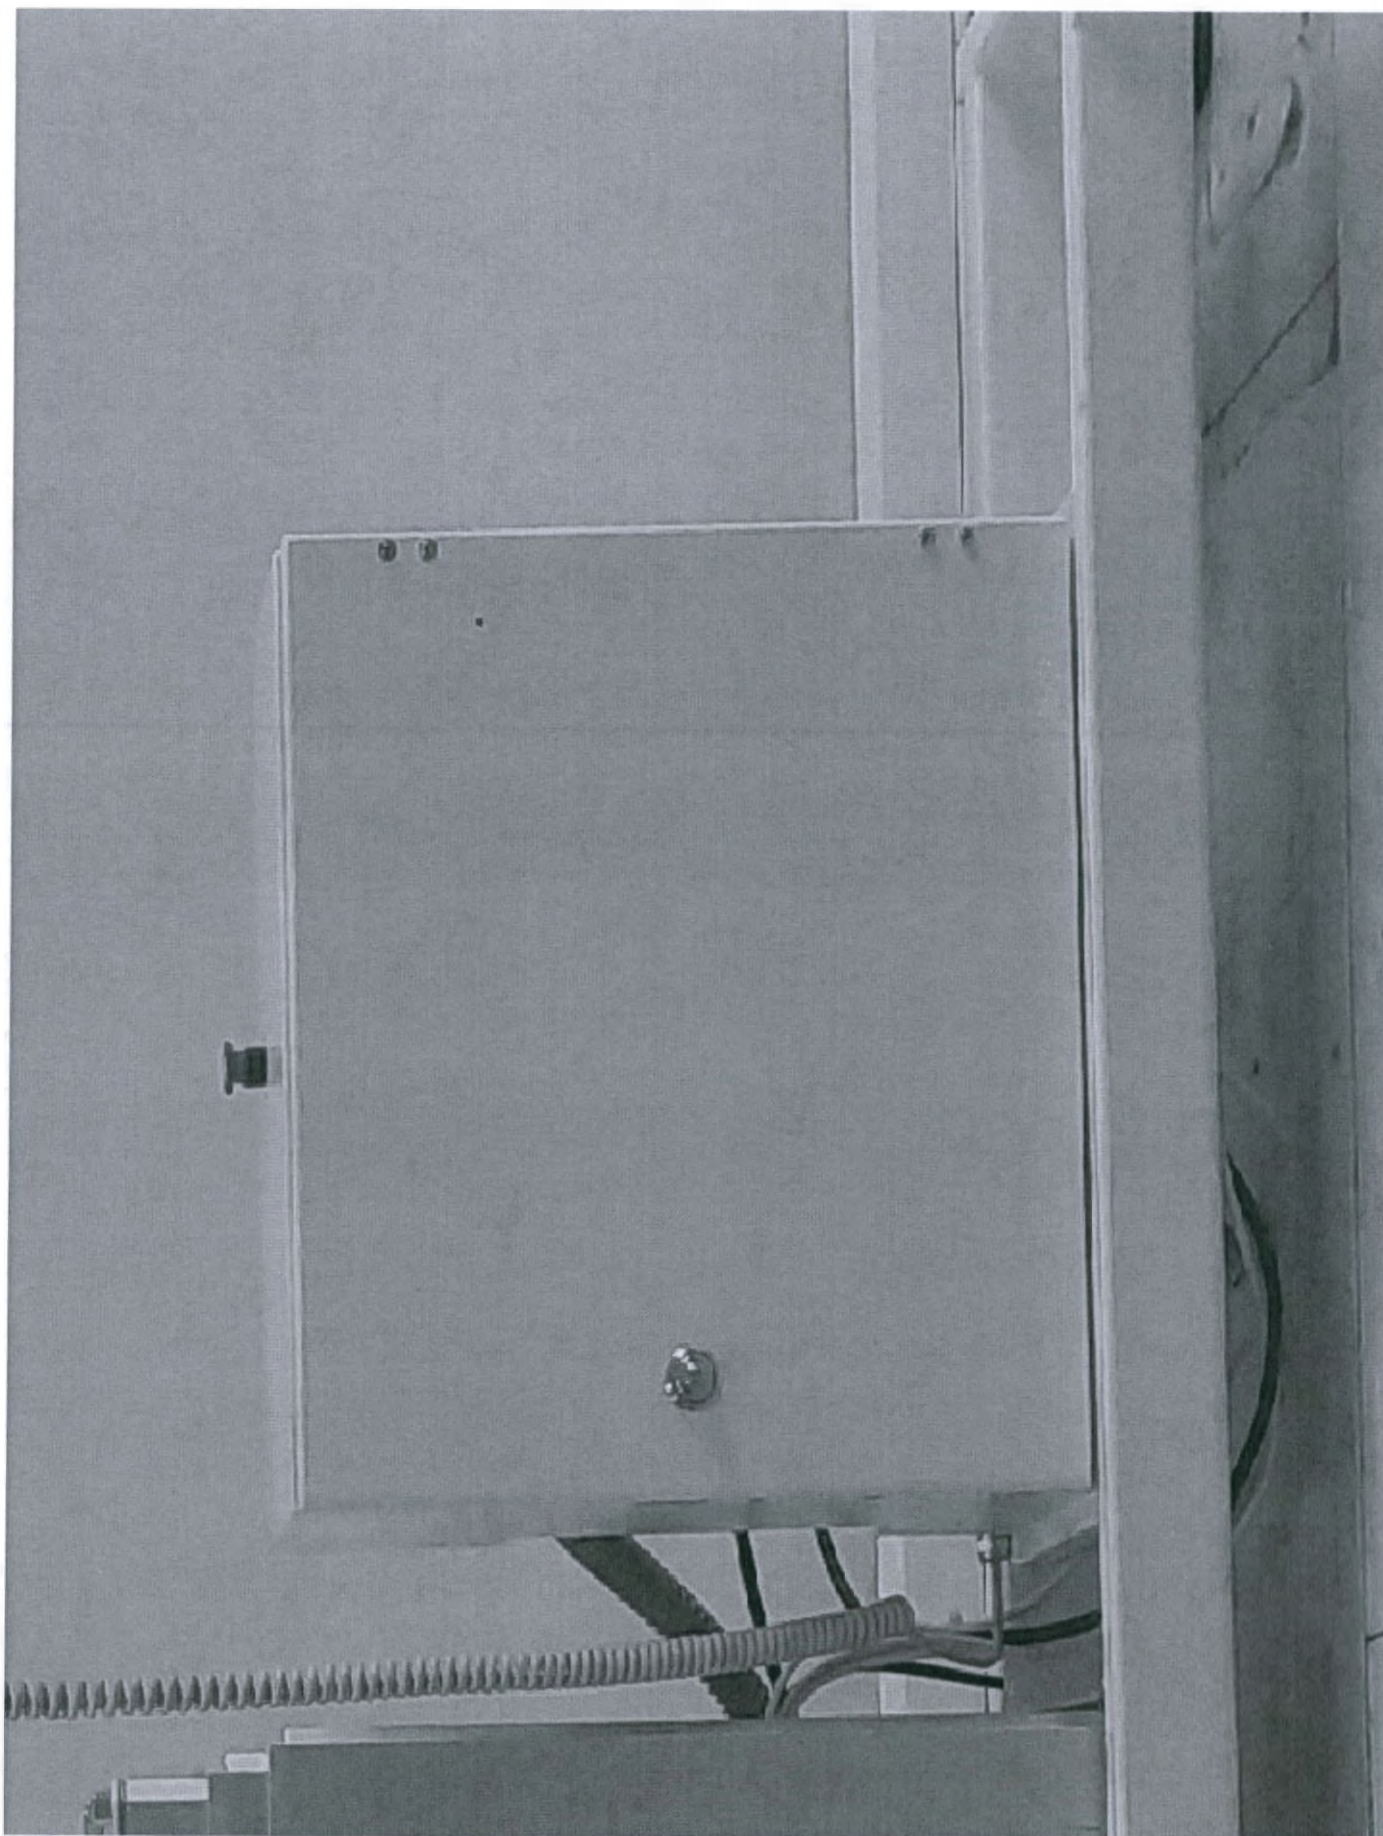


Рис 5. - Рентгеновское питающее устройство ЛЖКМ.943129.069

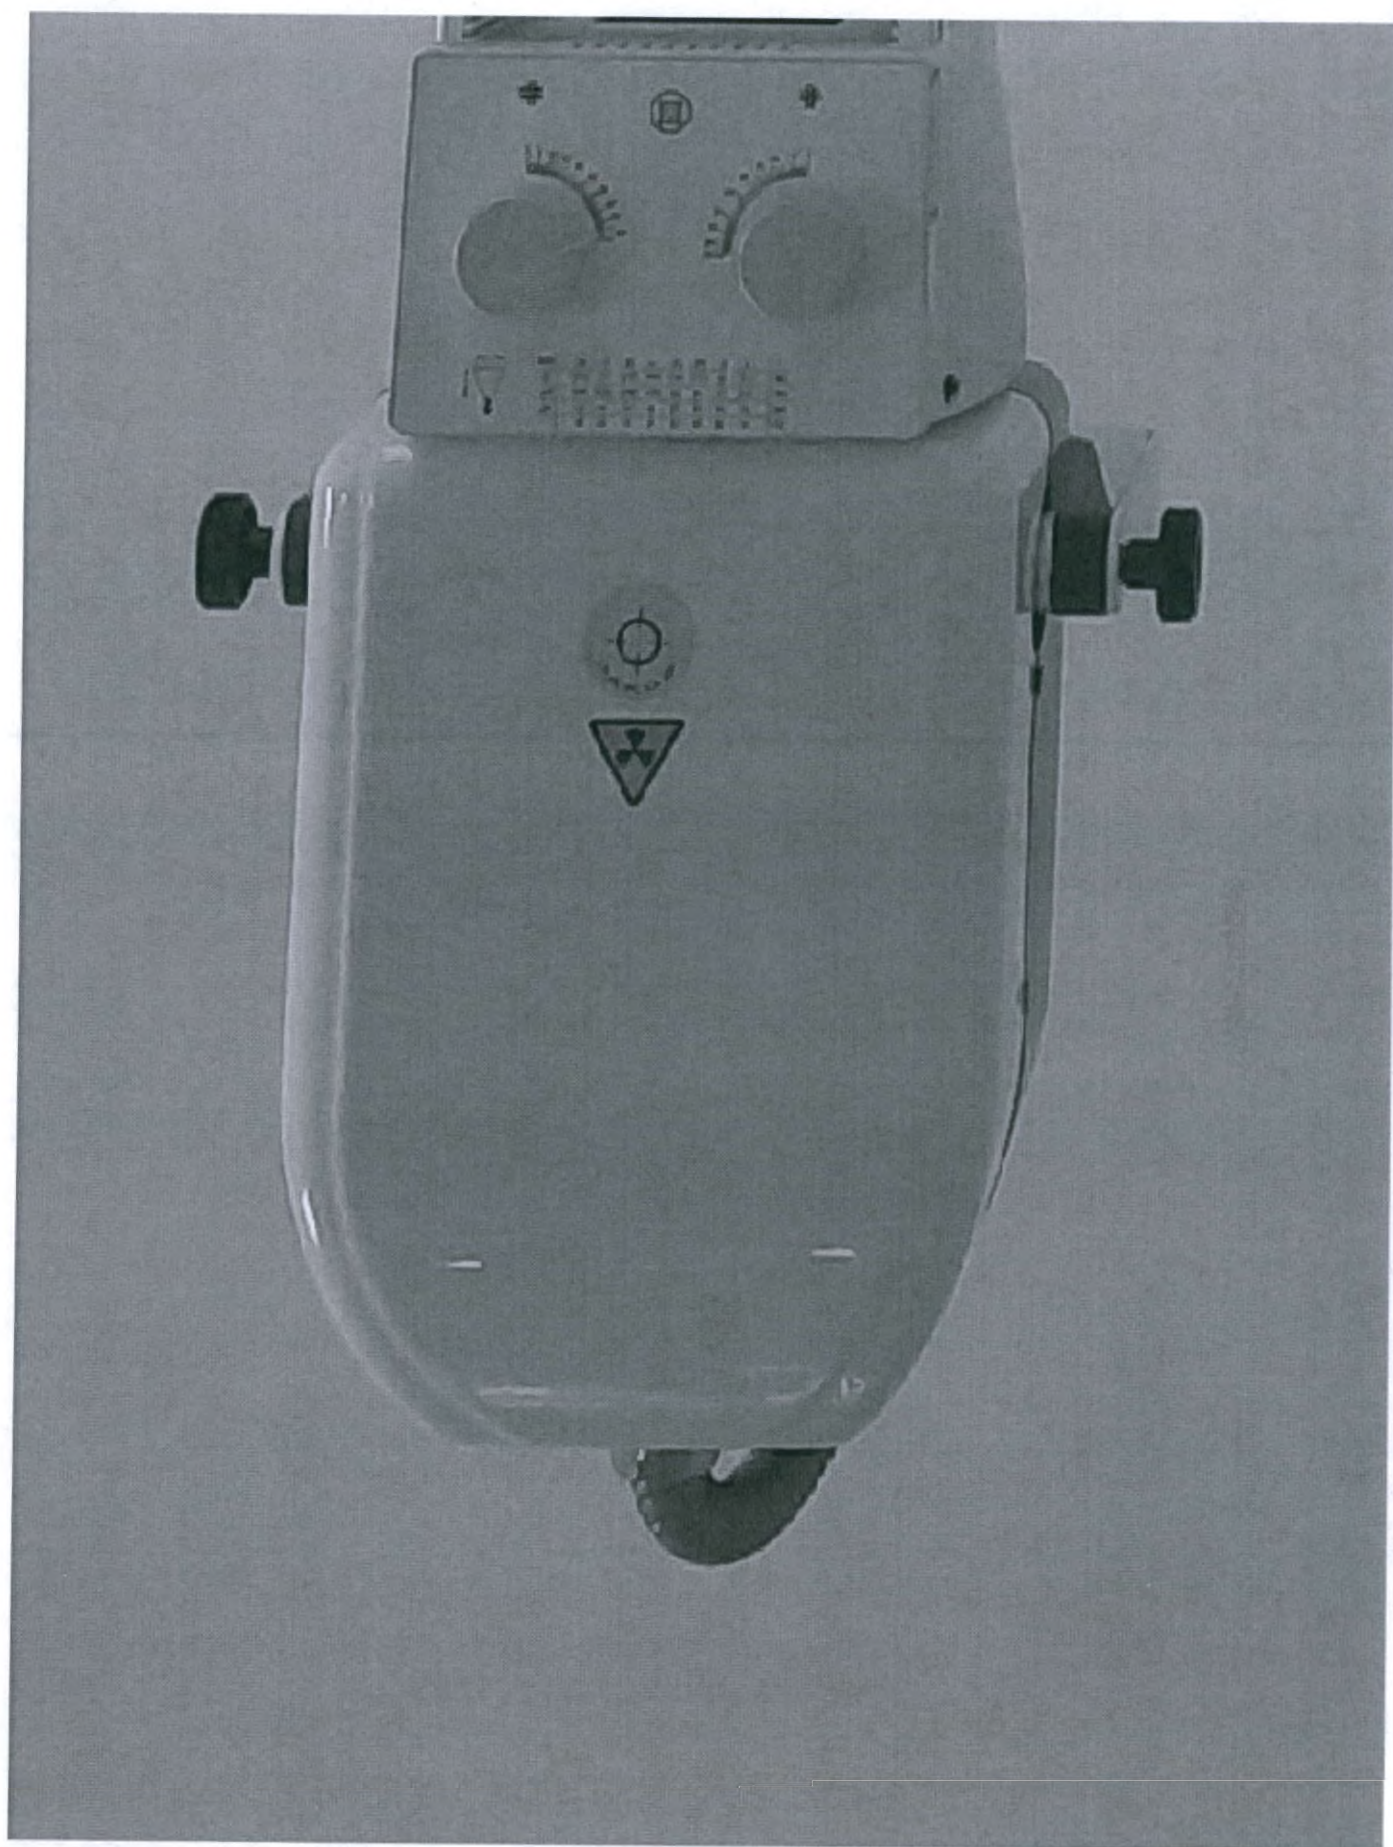


Рис 6. - Рентгеновский излучатель моноблочного типа ЛЖКМ.433251.002

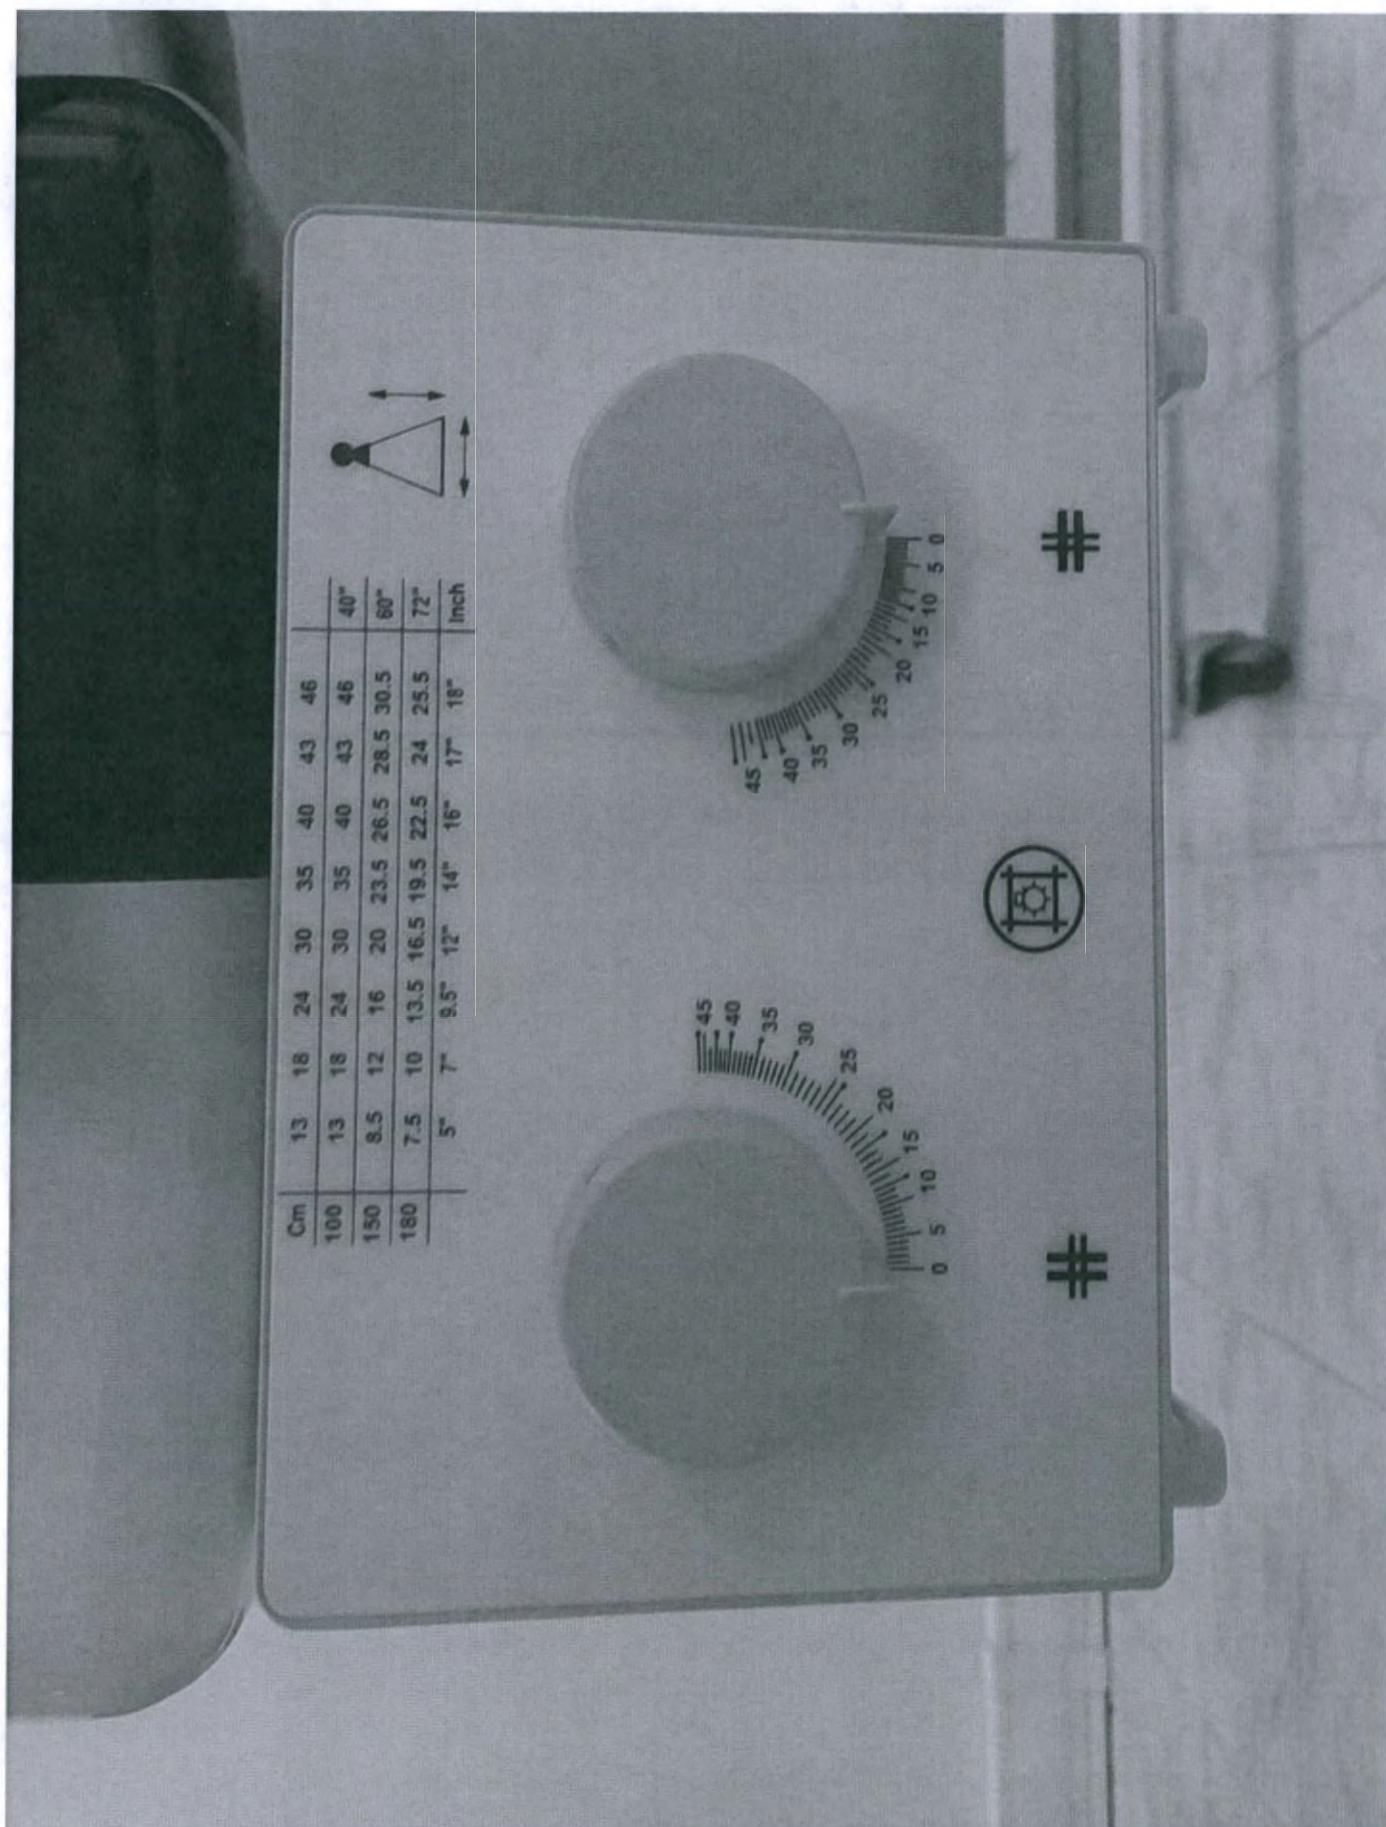


Рис 7. - Коллиматор серии R

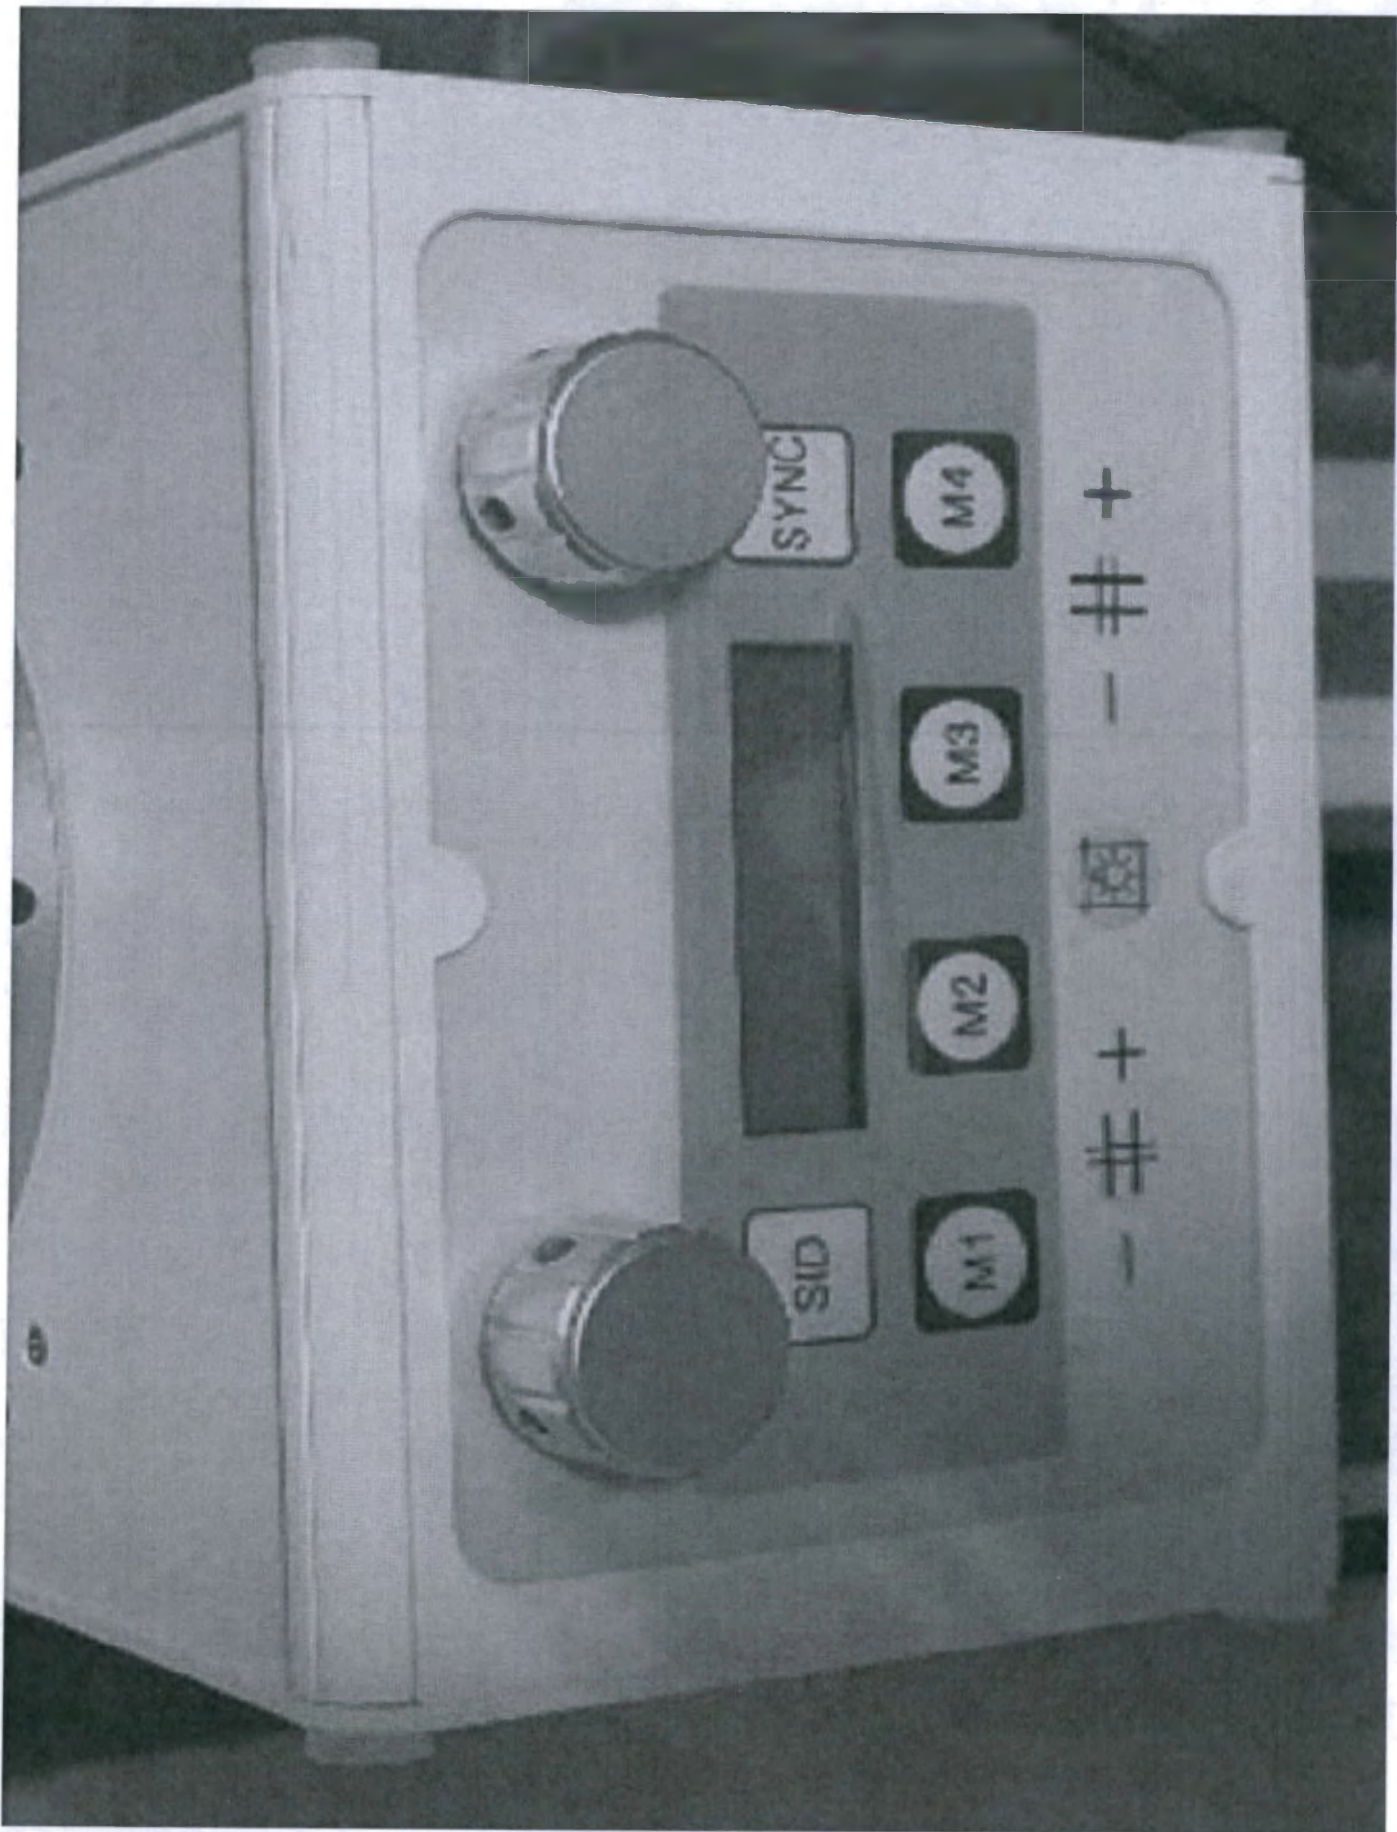


Рис 8. - Коллиматор модель FA38

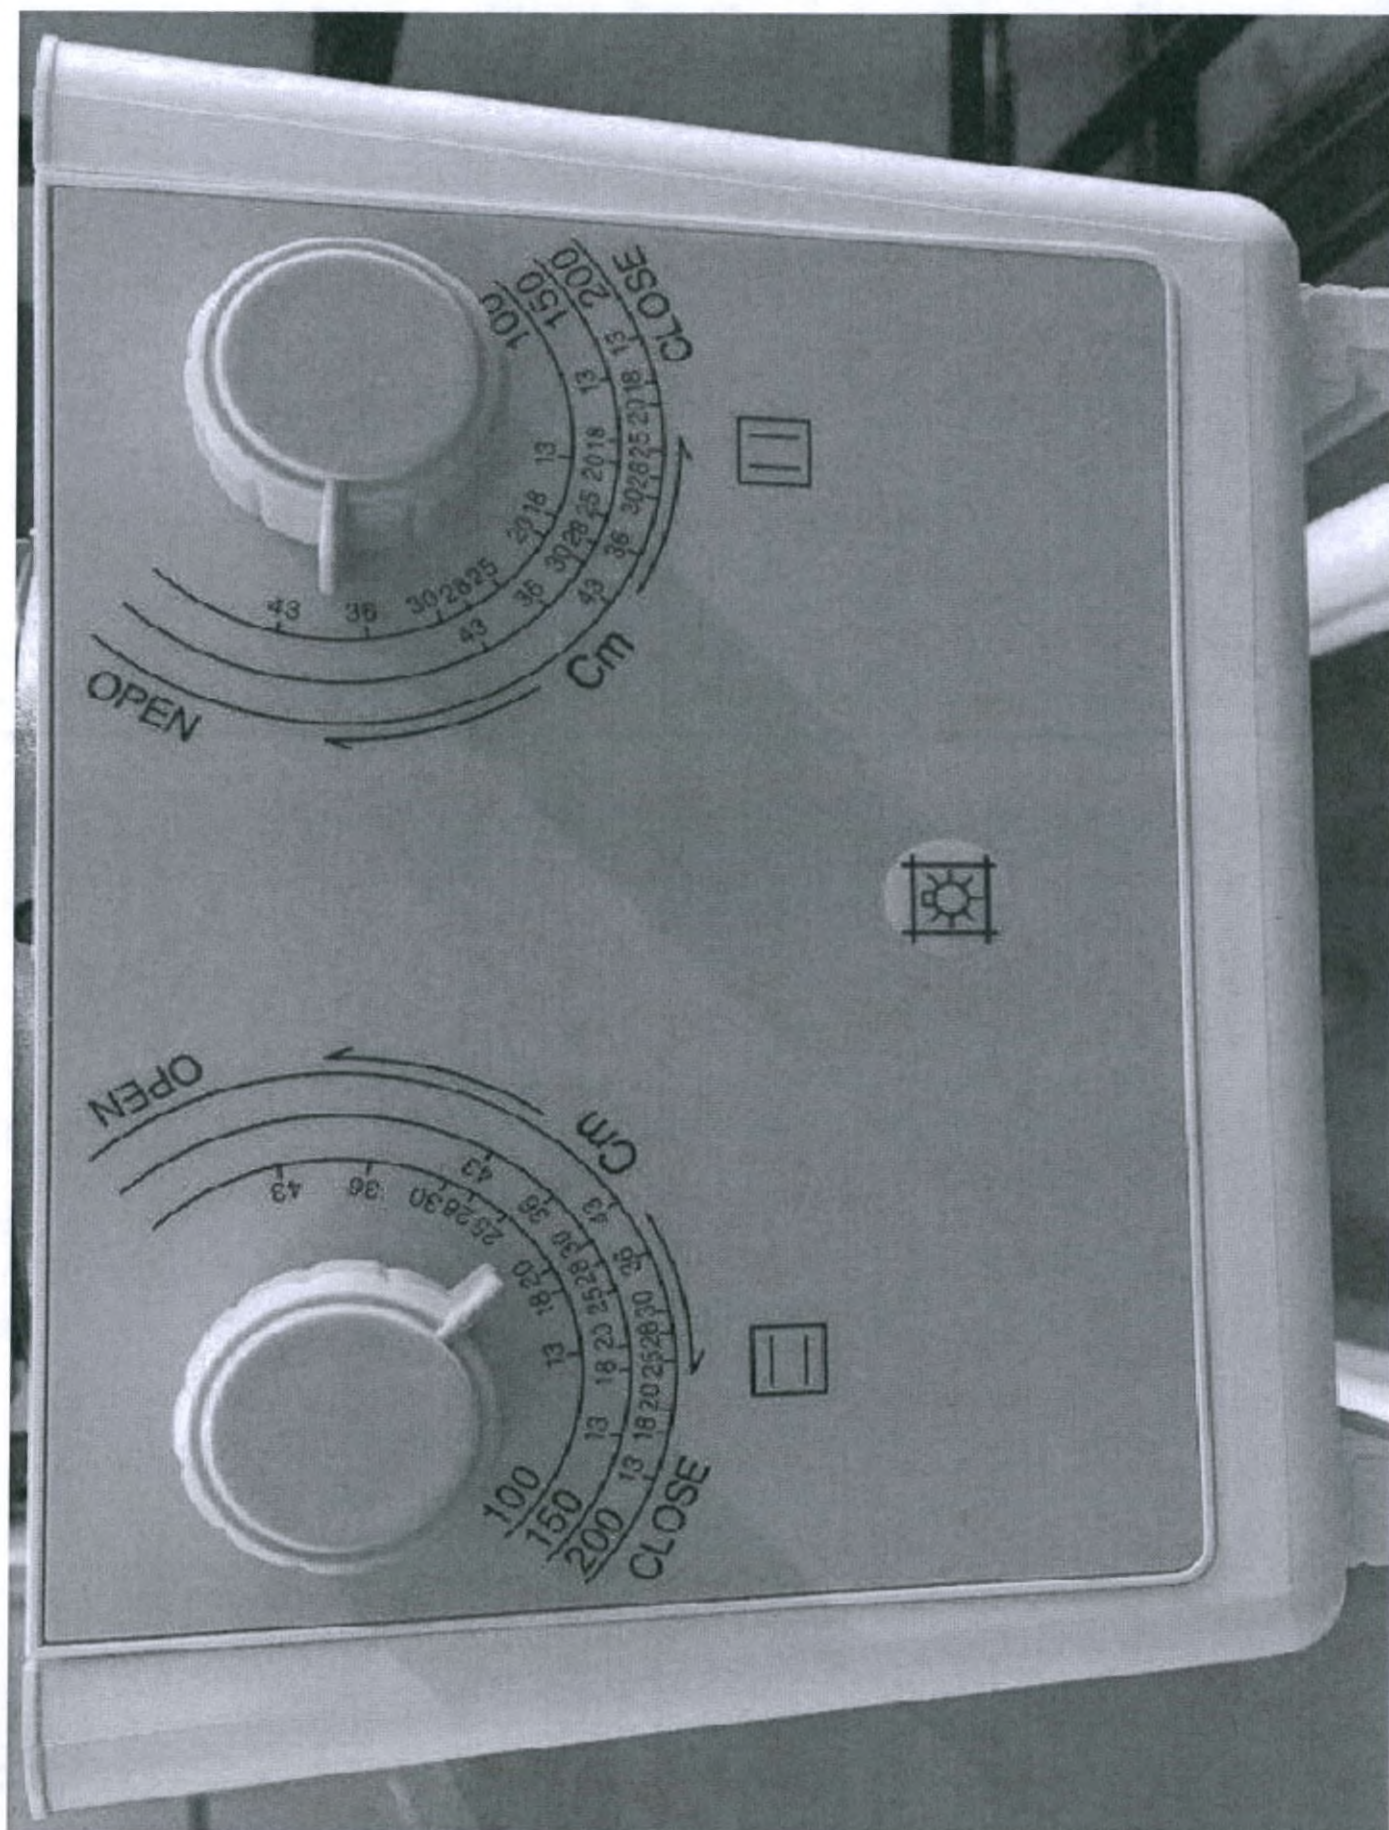


Рис 9. - Коллиматор модель М38



Рис 10. - Пульт управления перемещением штатива ЛЖКМ.943129.070

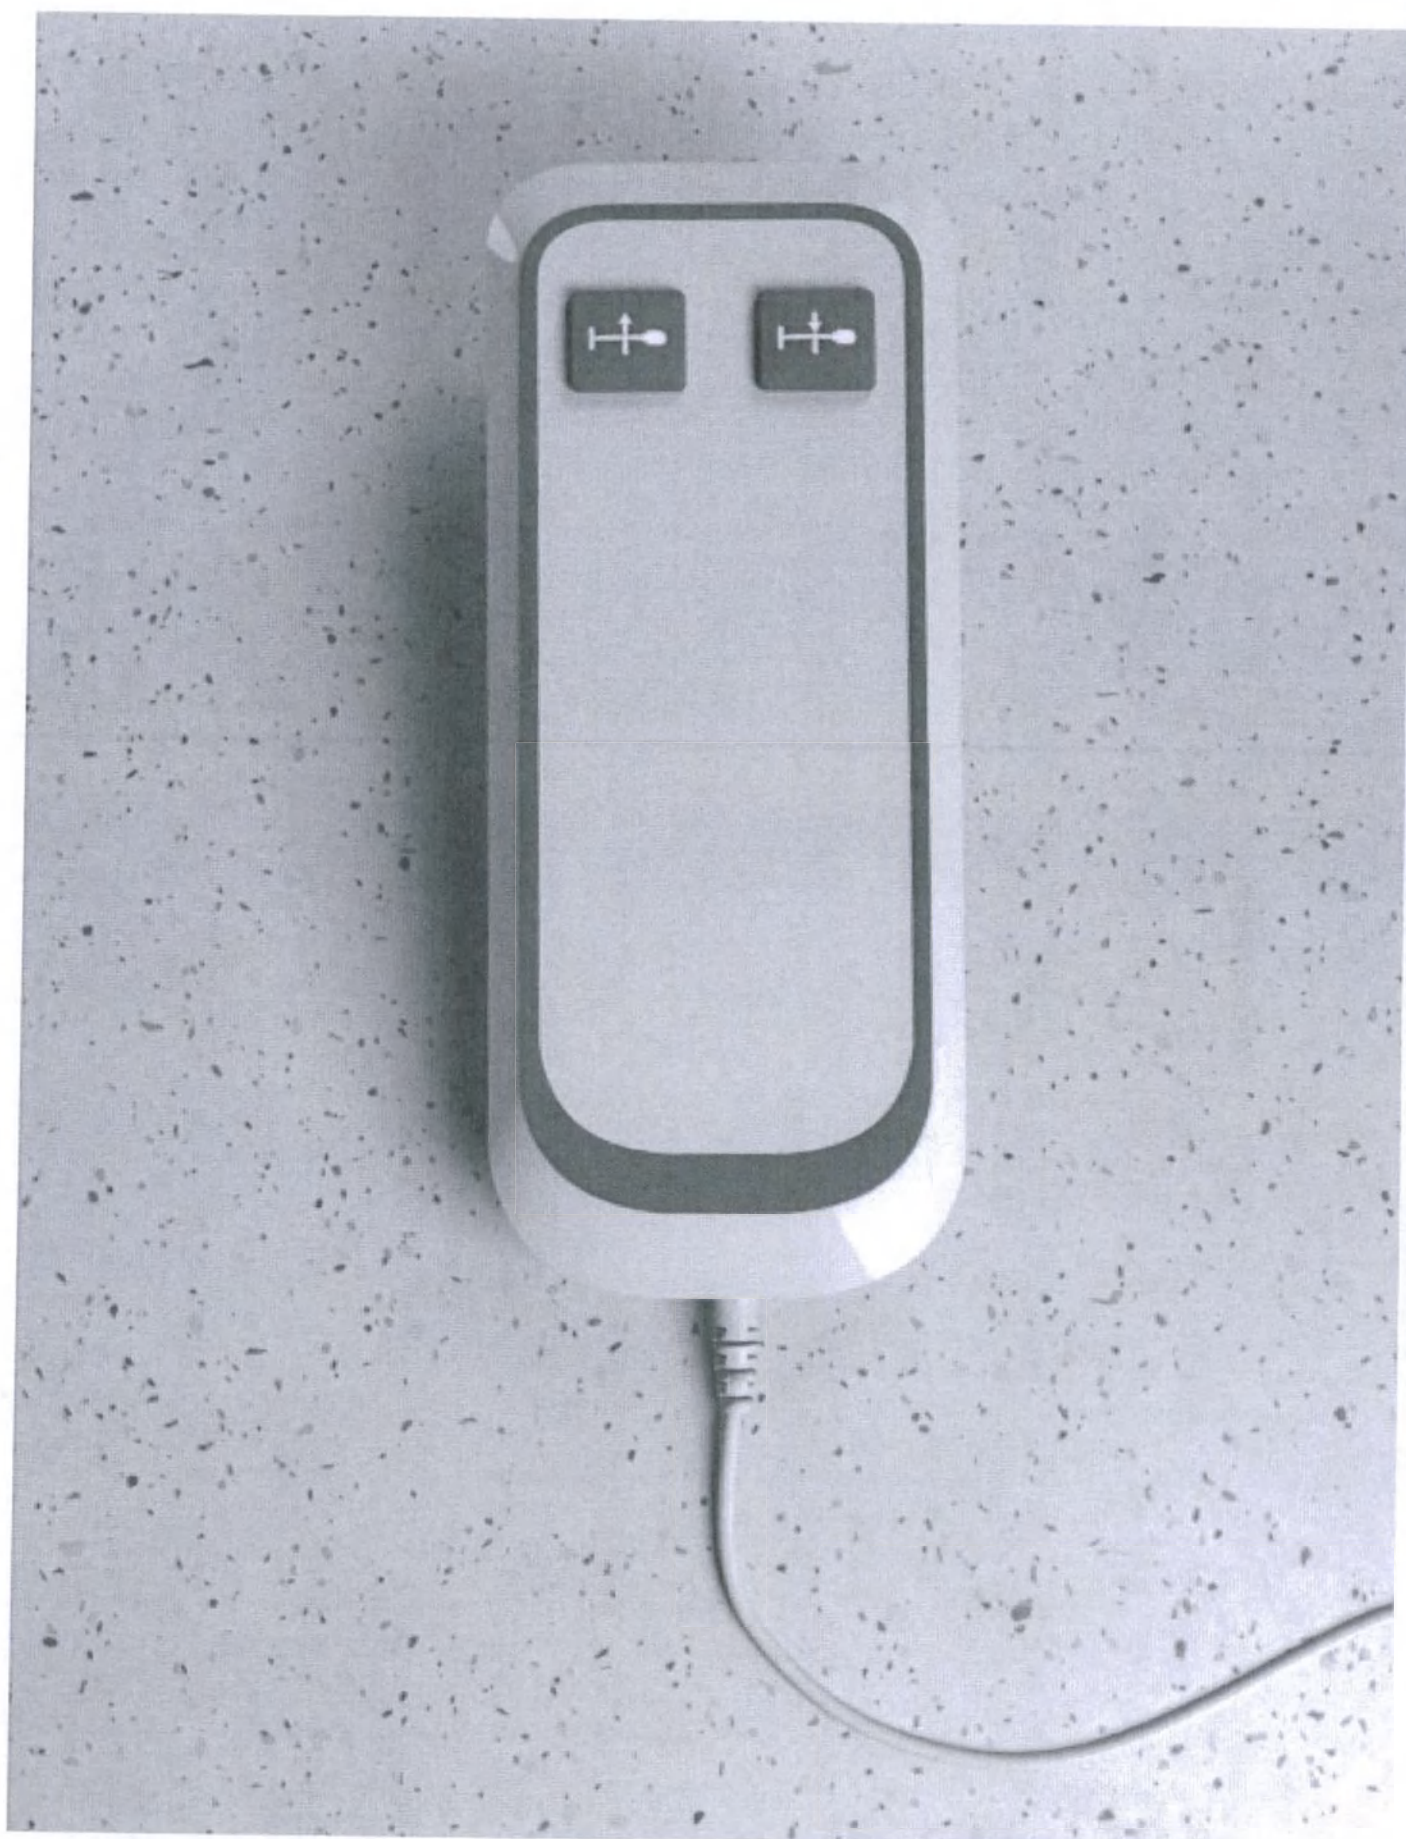


Рис 11. - Пульт управления перемещением штатива ЛЖКМ.943129.071



Рис 12. - Кабель сетевой

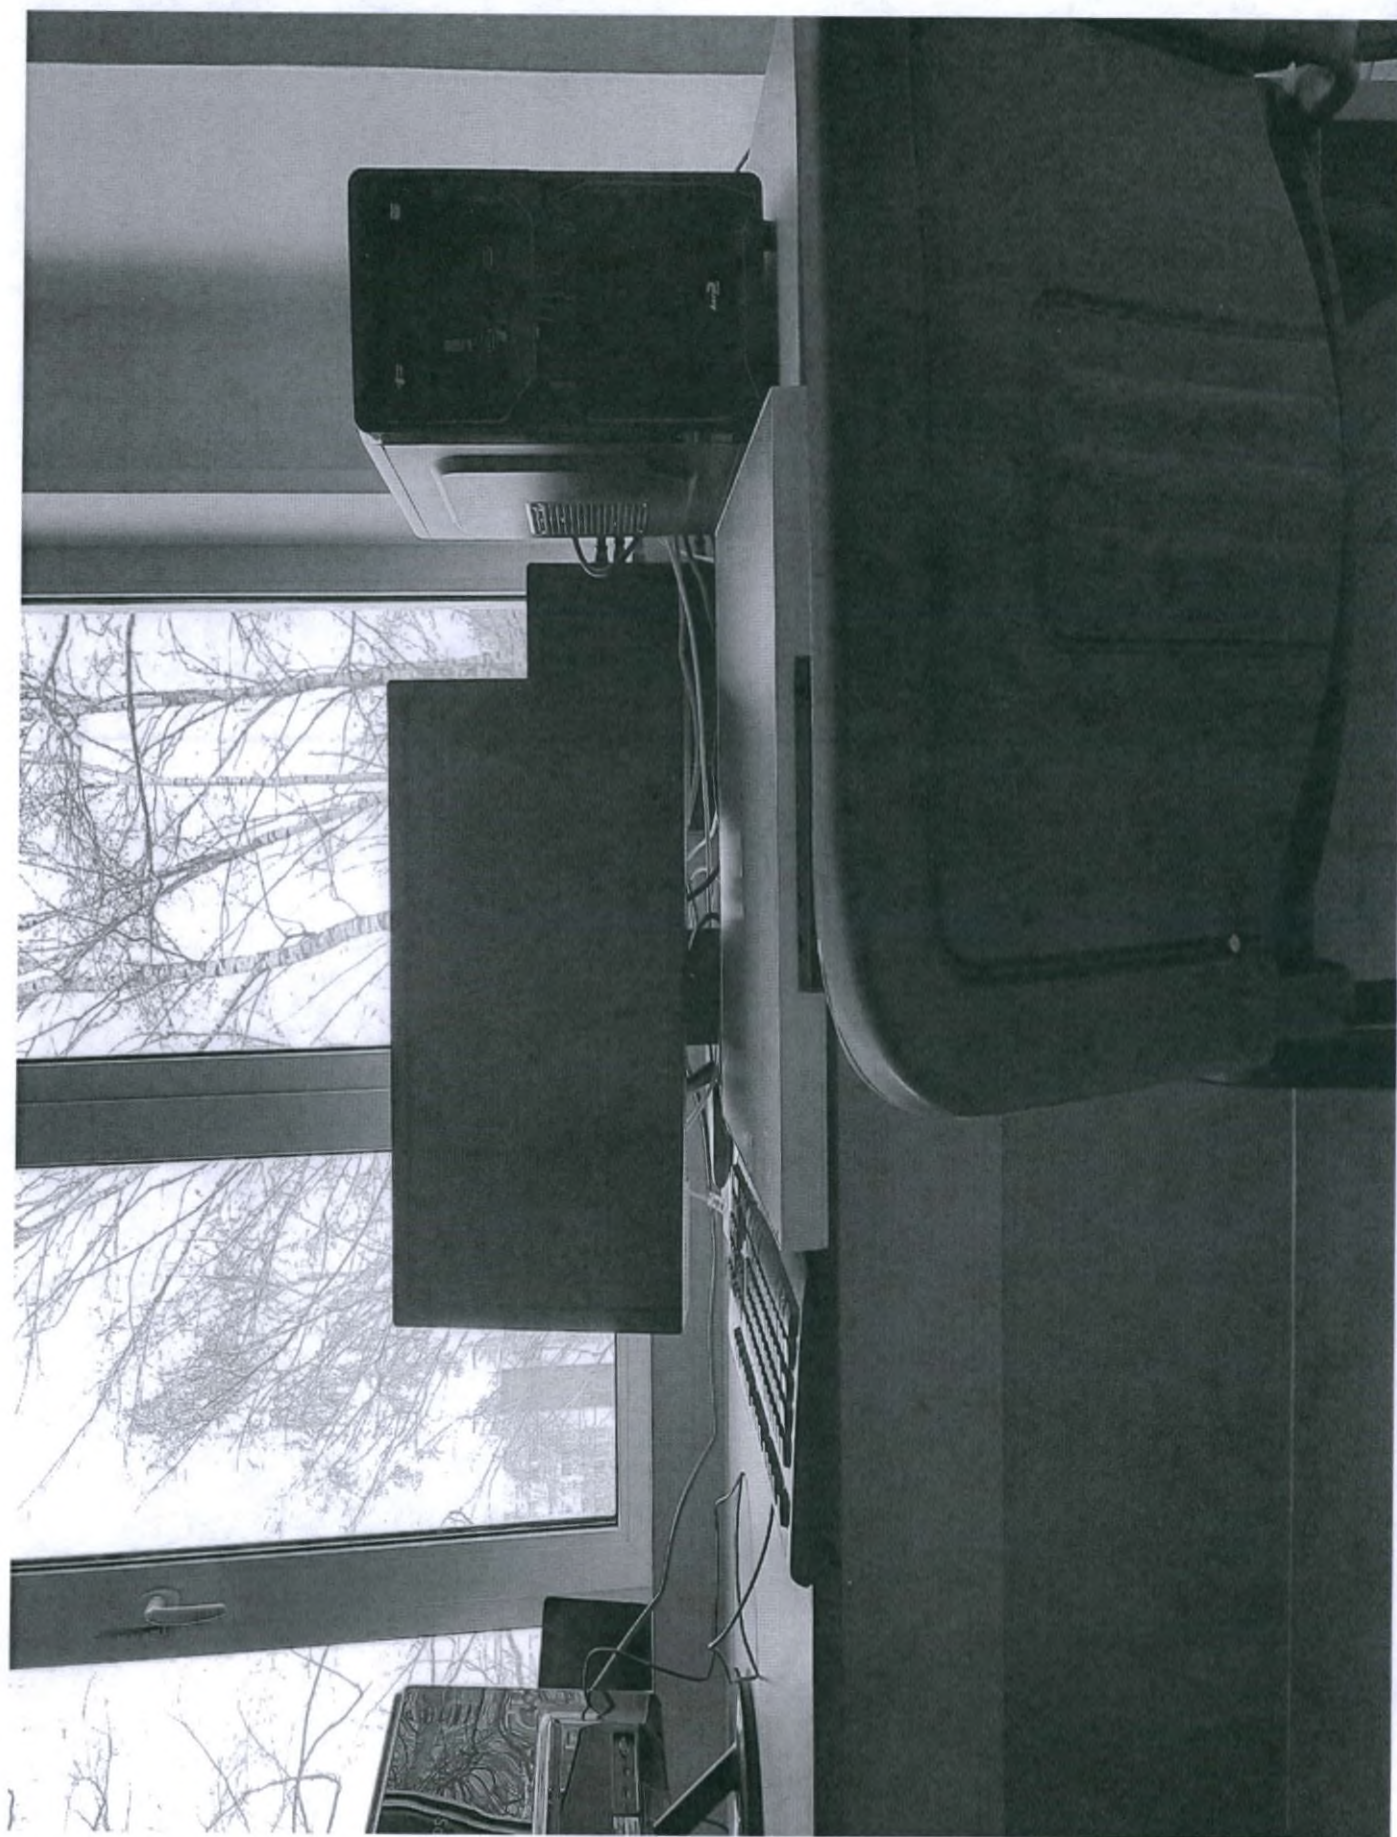


Рис 13. - Устройство рентгенографическое цифровое УРЦ-М-«РЕНЕКС» по ТУ 9442-032-54839165-2011

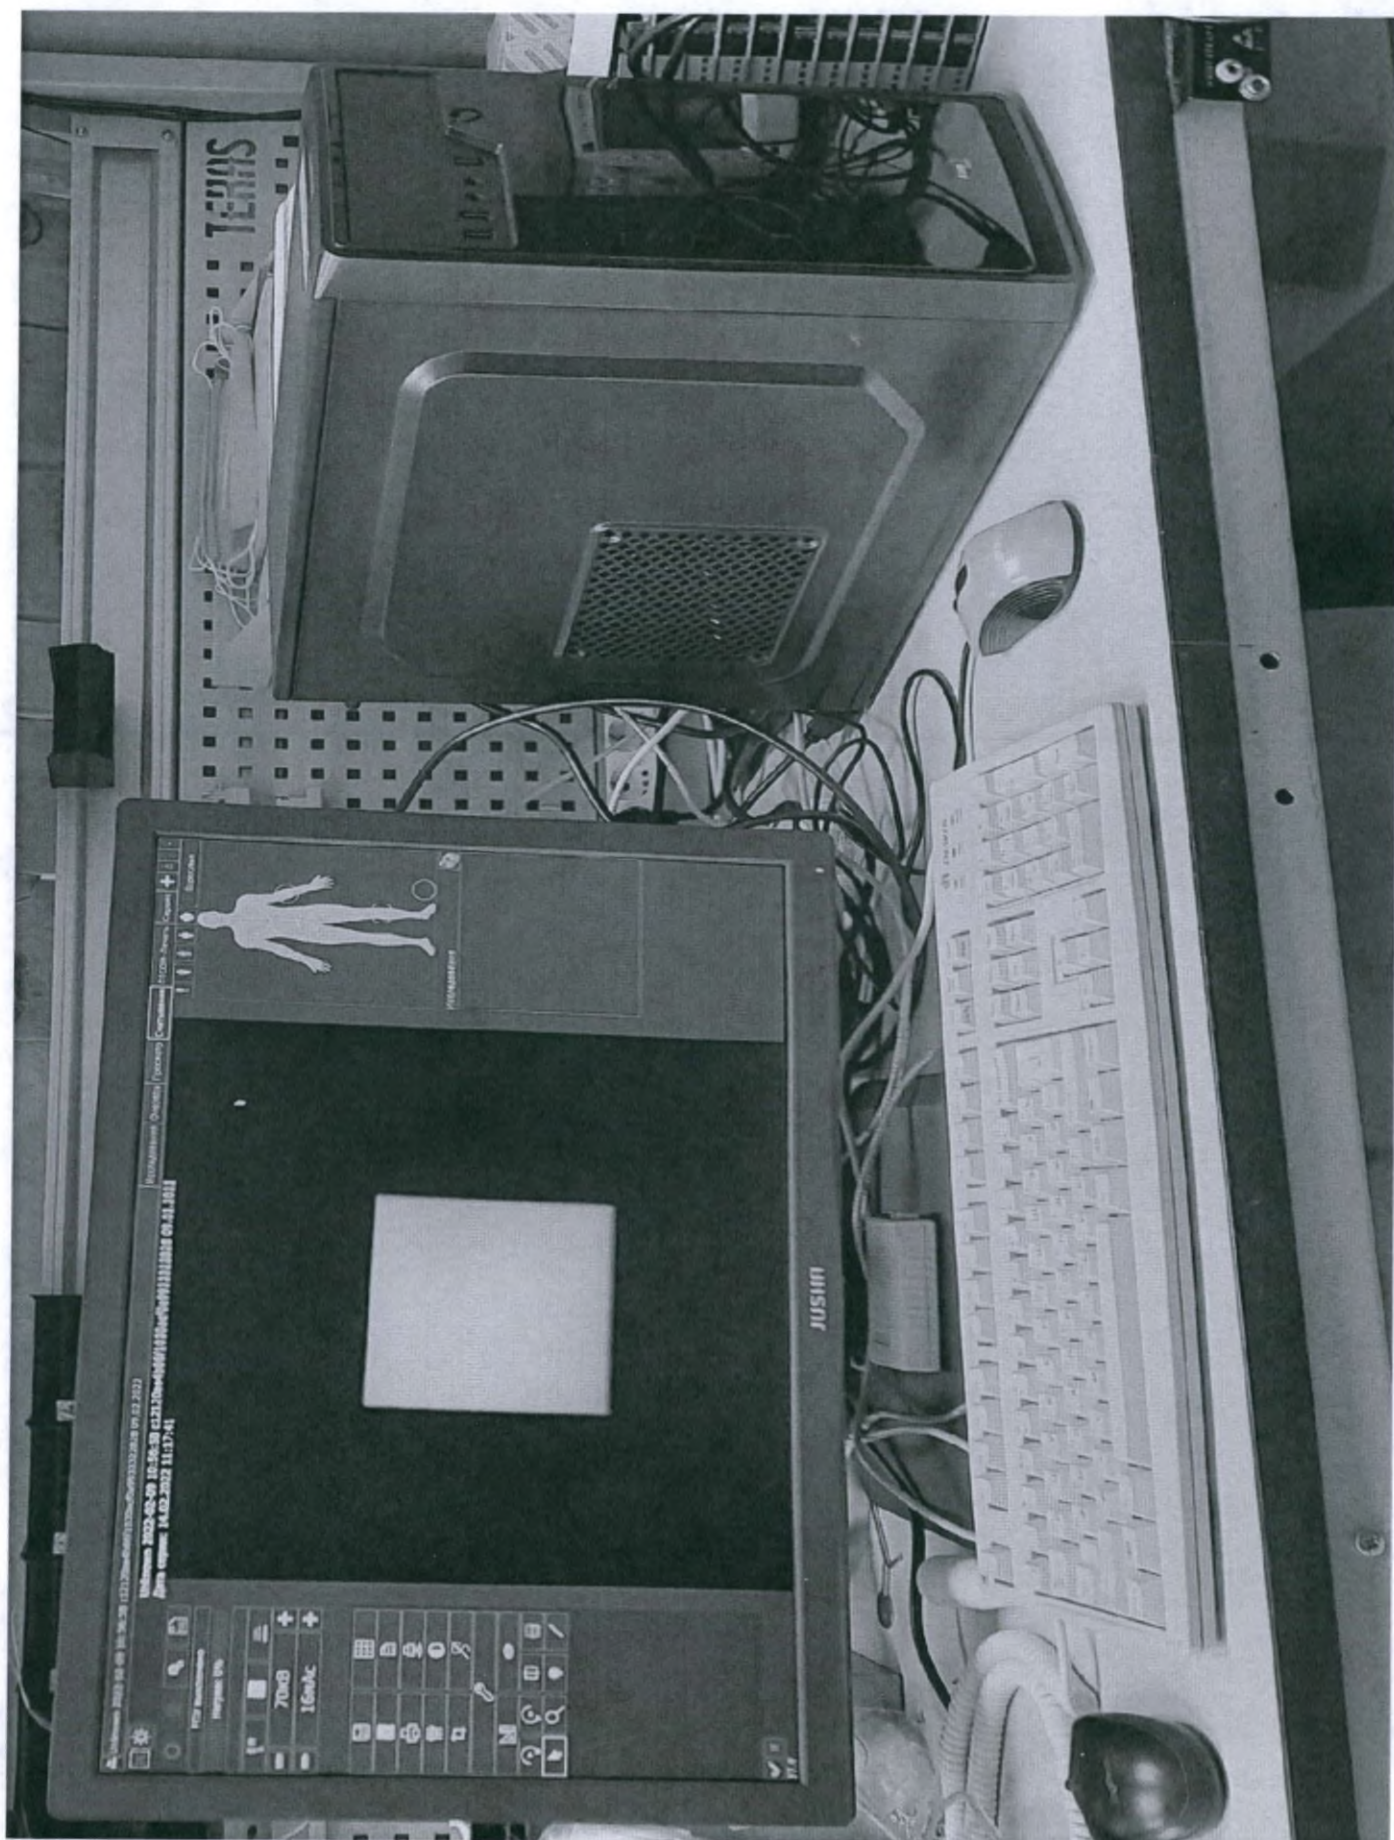


Рис 14. - АРМ рентгенолаборанта ЛЖКМ.466216.001

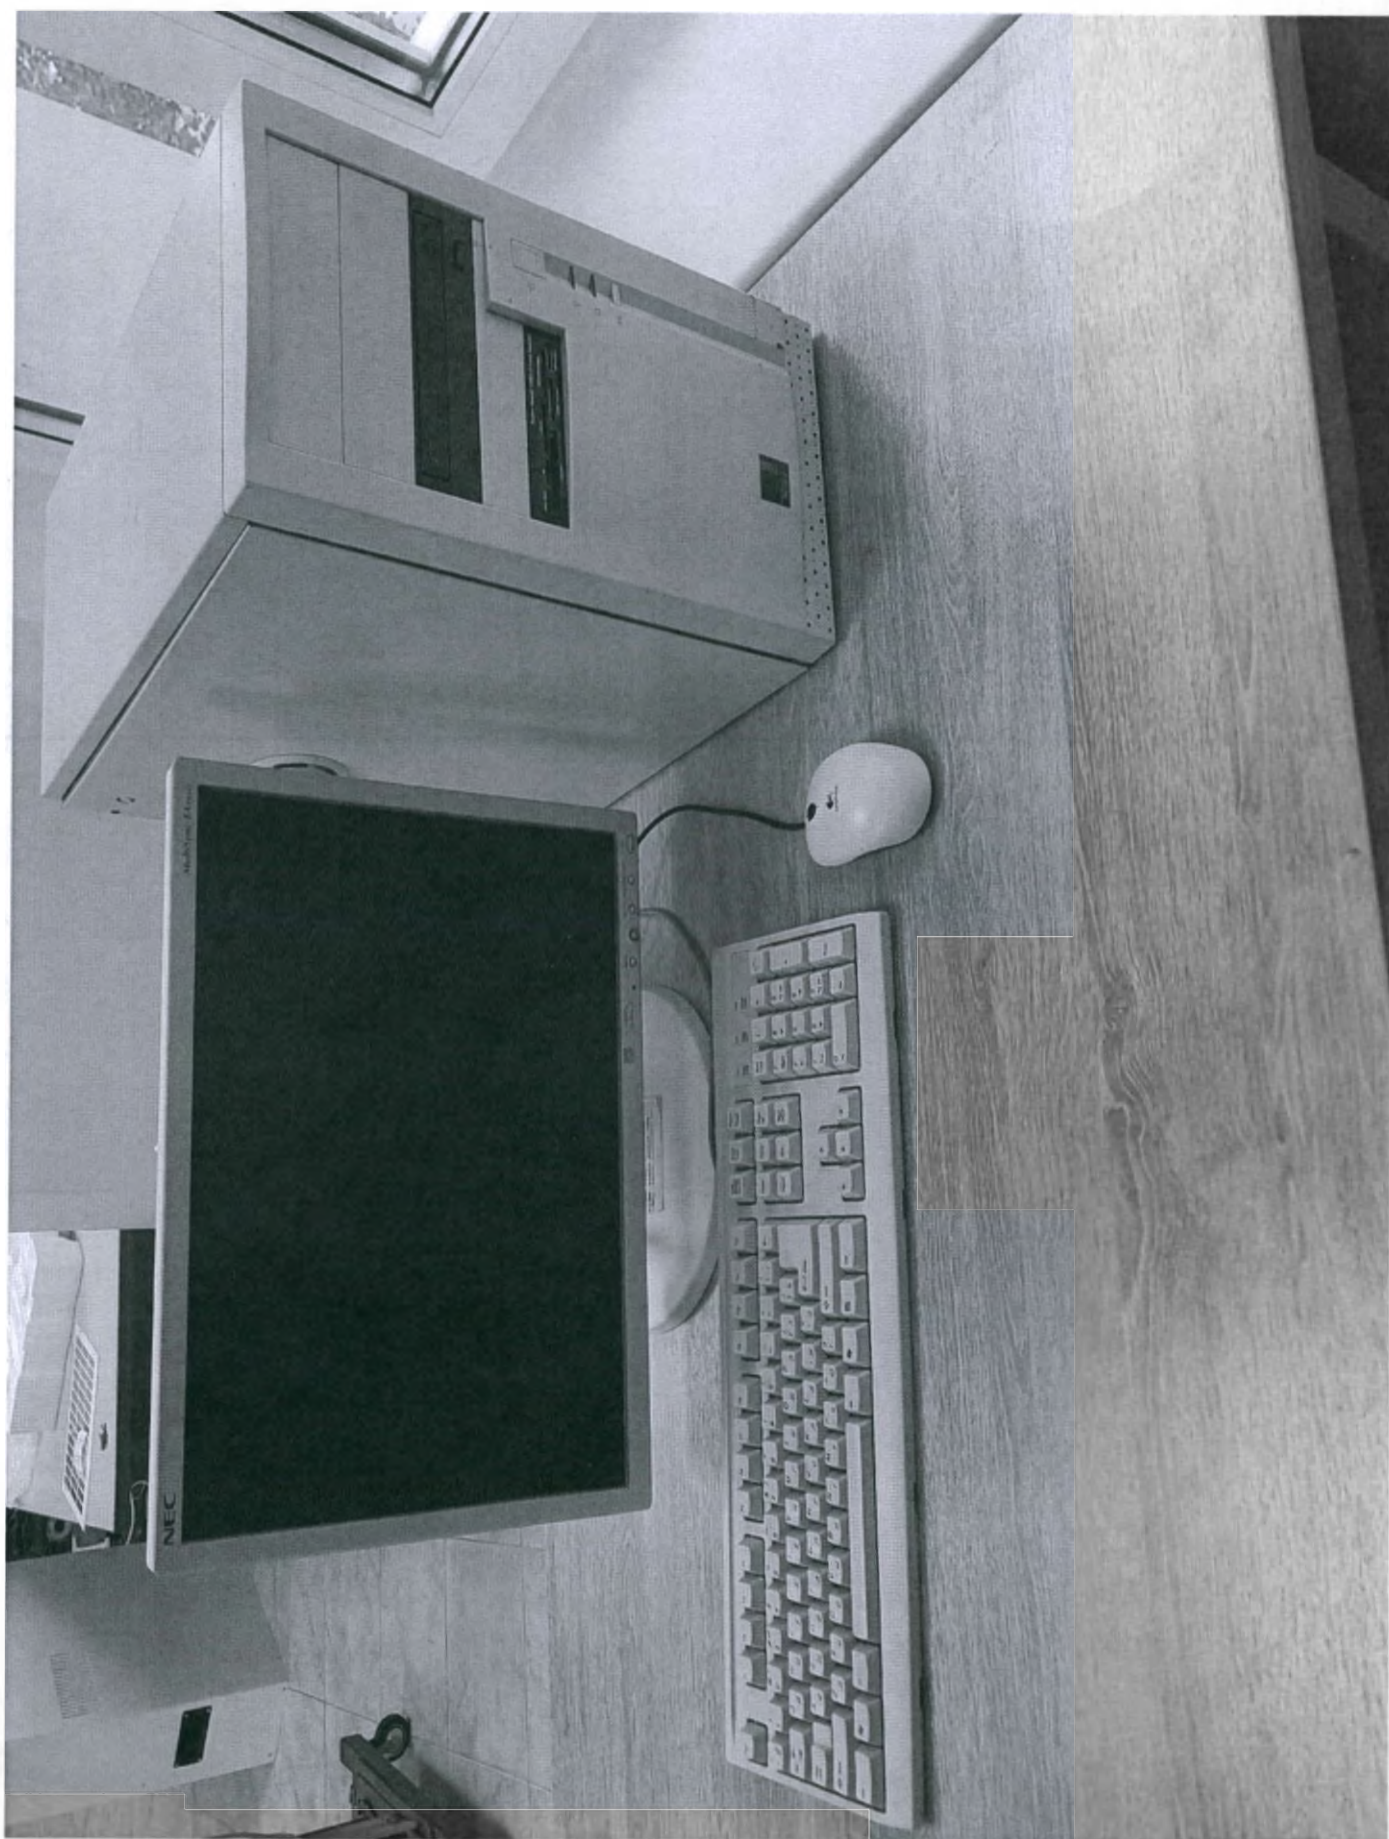


Рис 15. - Объединенное АРМ ЛЖКМ.466216.004

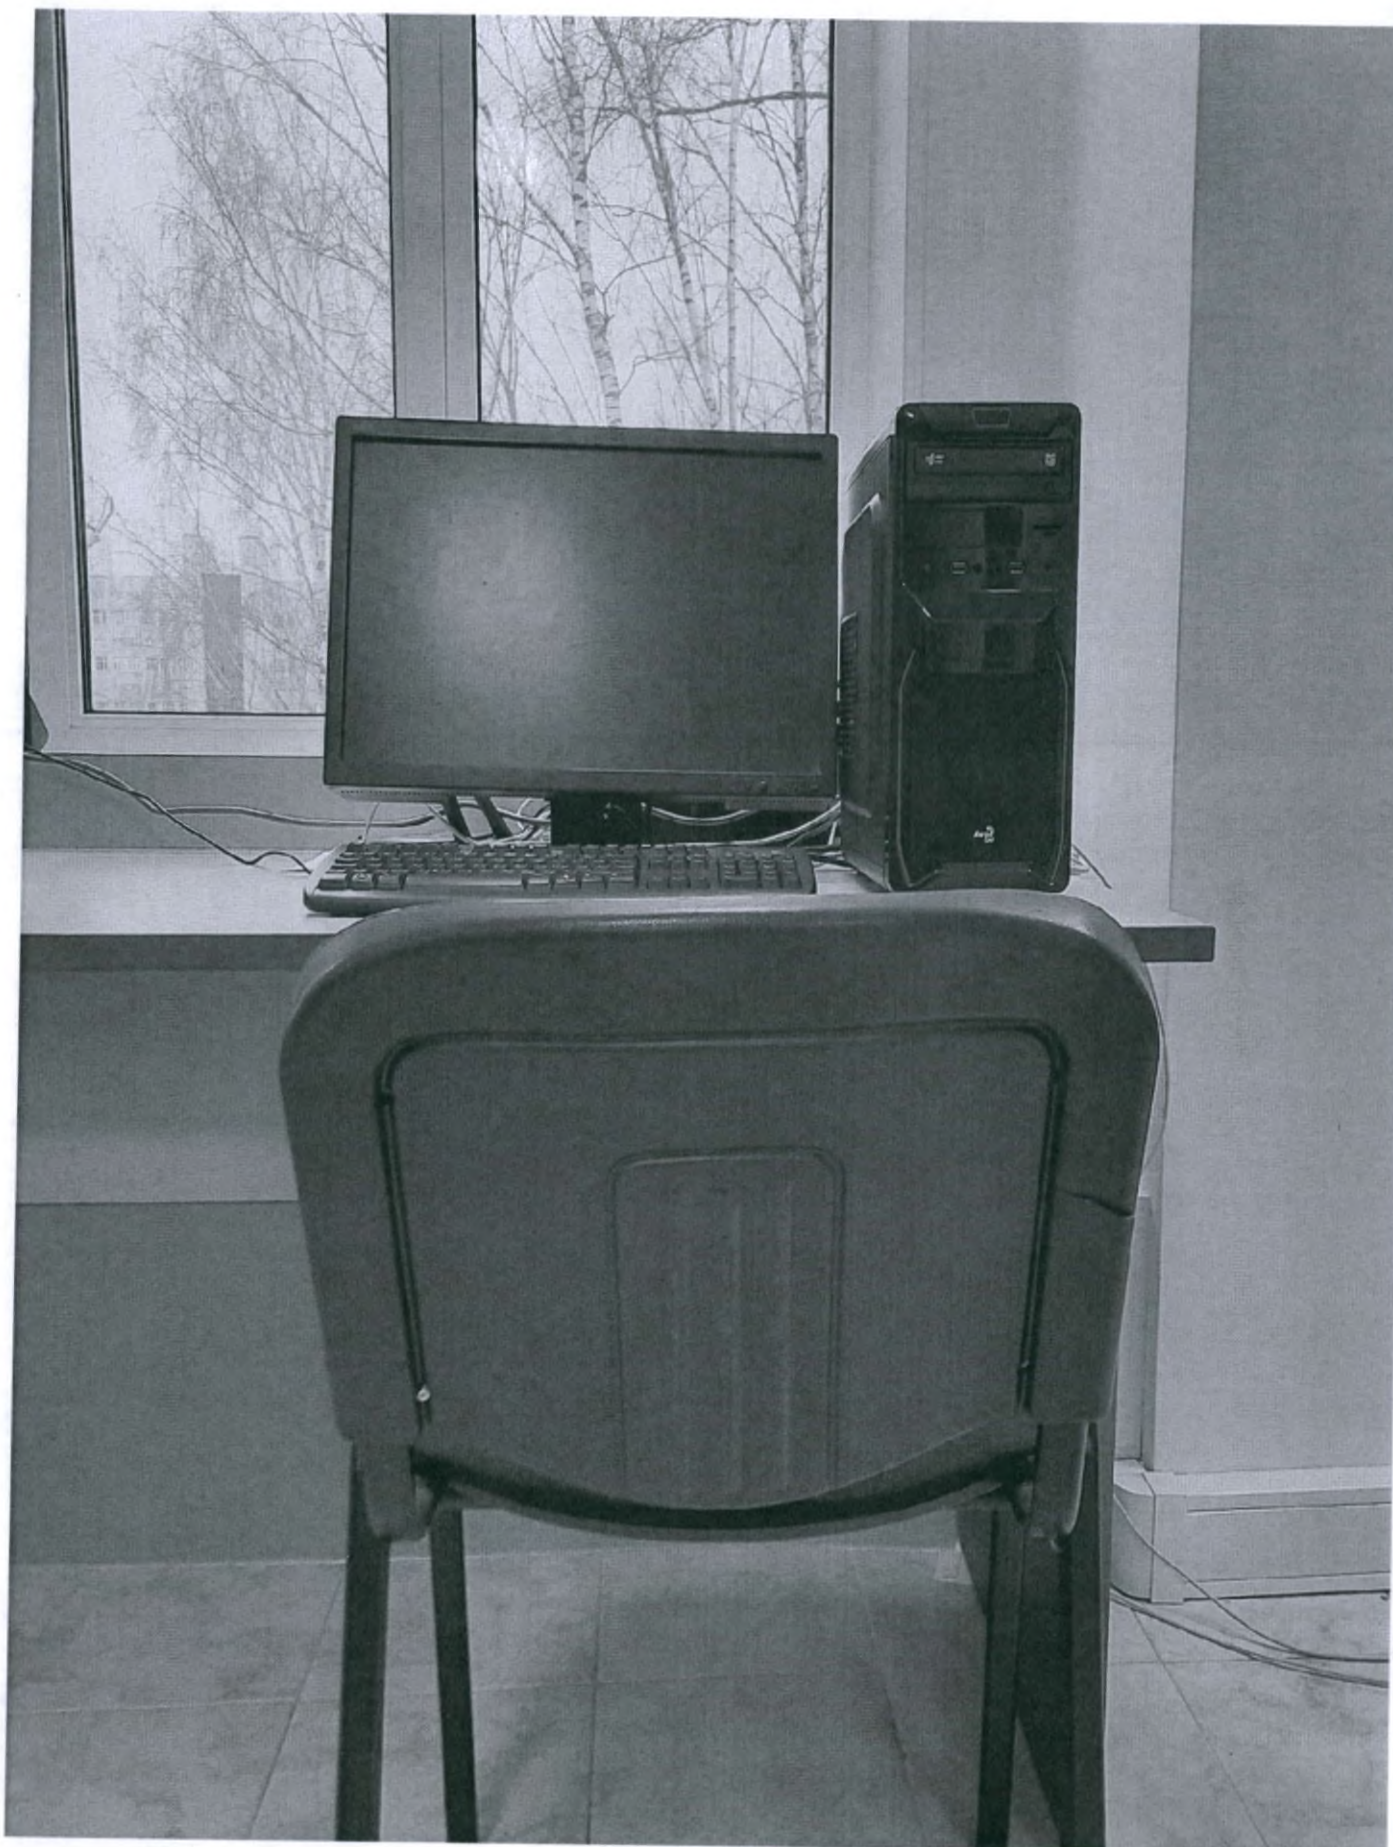


Рис 16. - АРМ врача-рентгенолога ЛЖКМ.466216.002



Рис 17. - Комплекс аппаратно-программный



Рис 18. - Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012

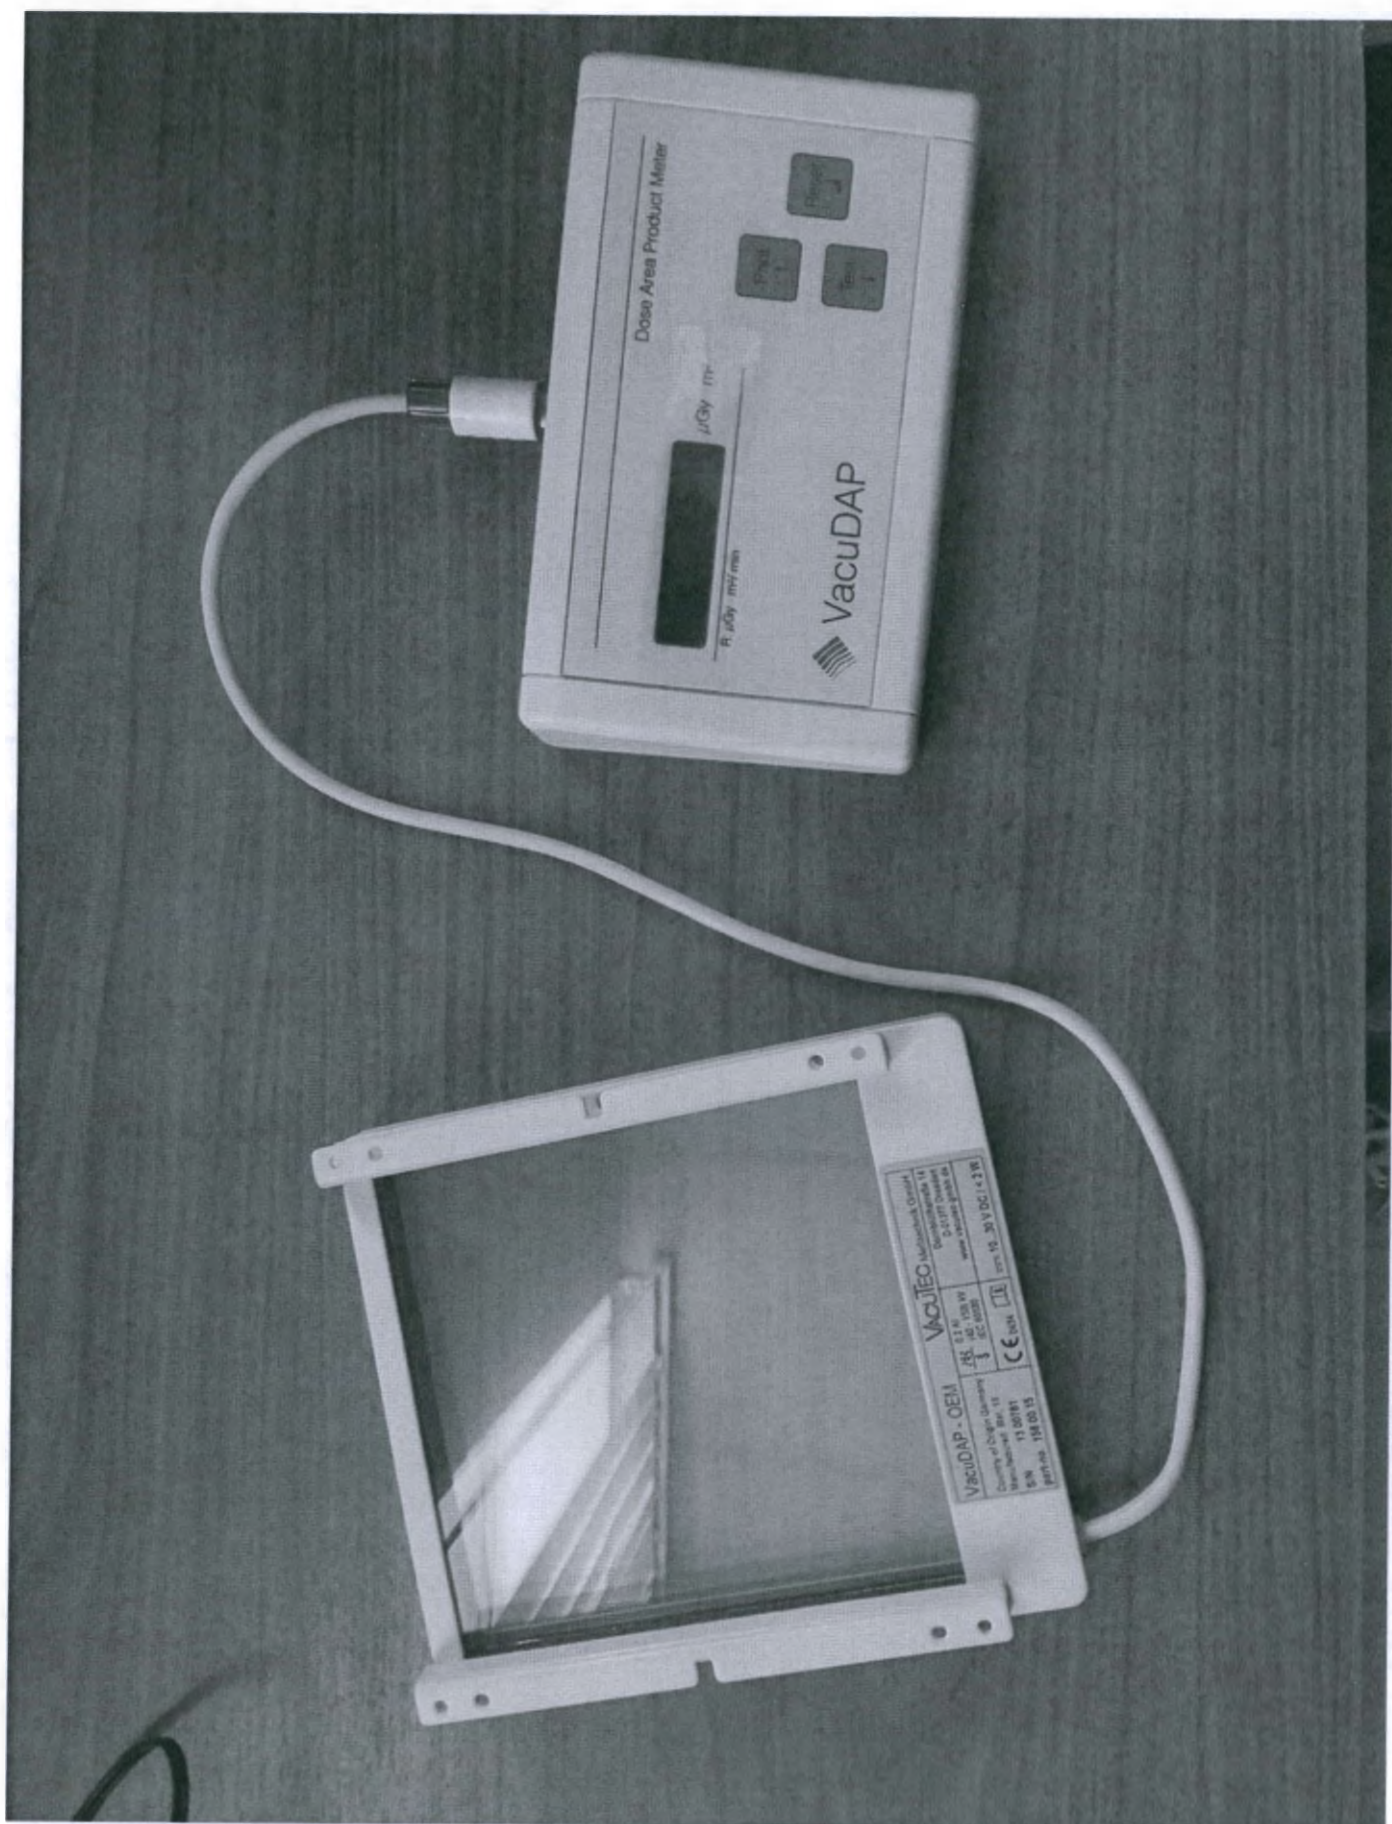


Рис 19. - Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDAP System

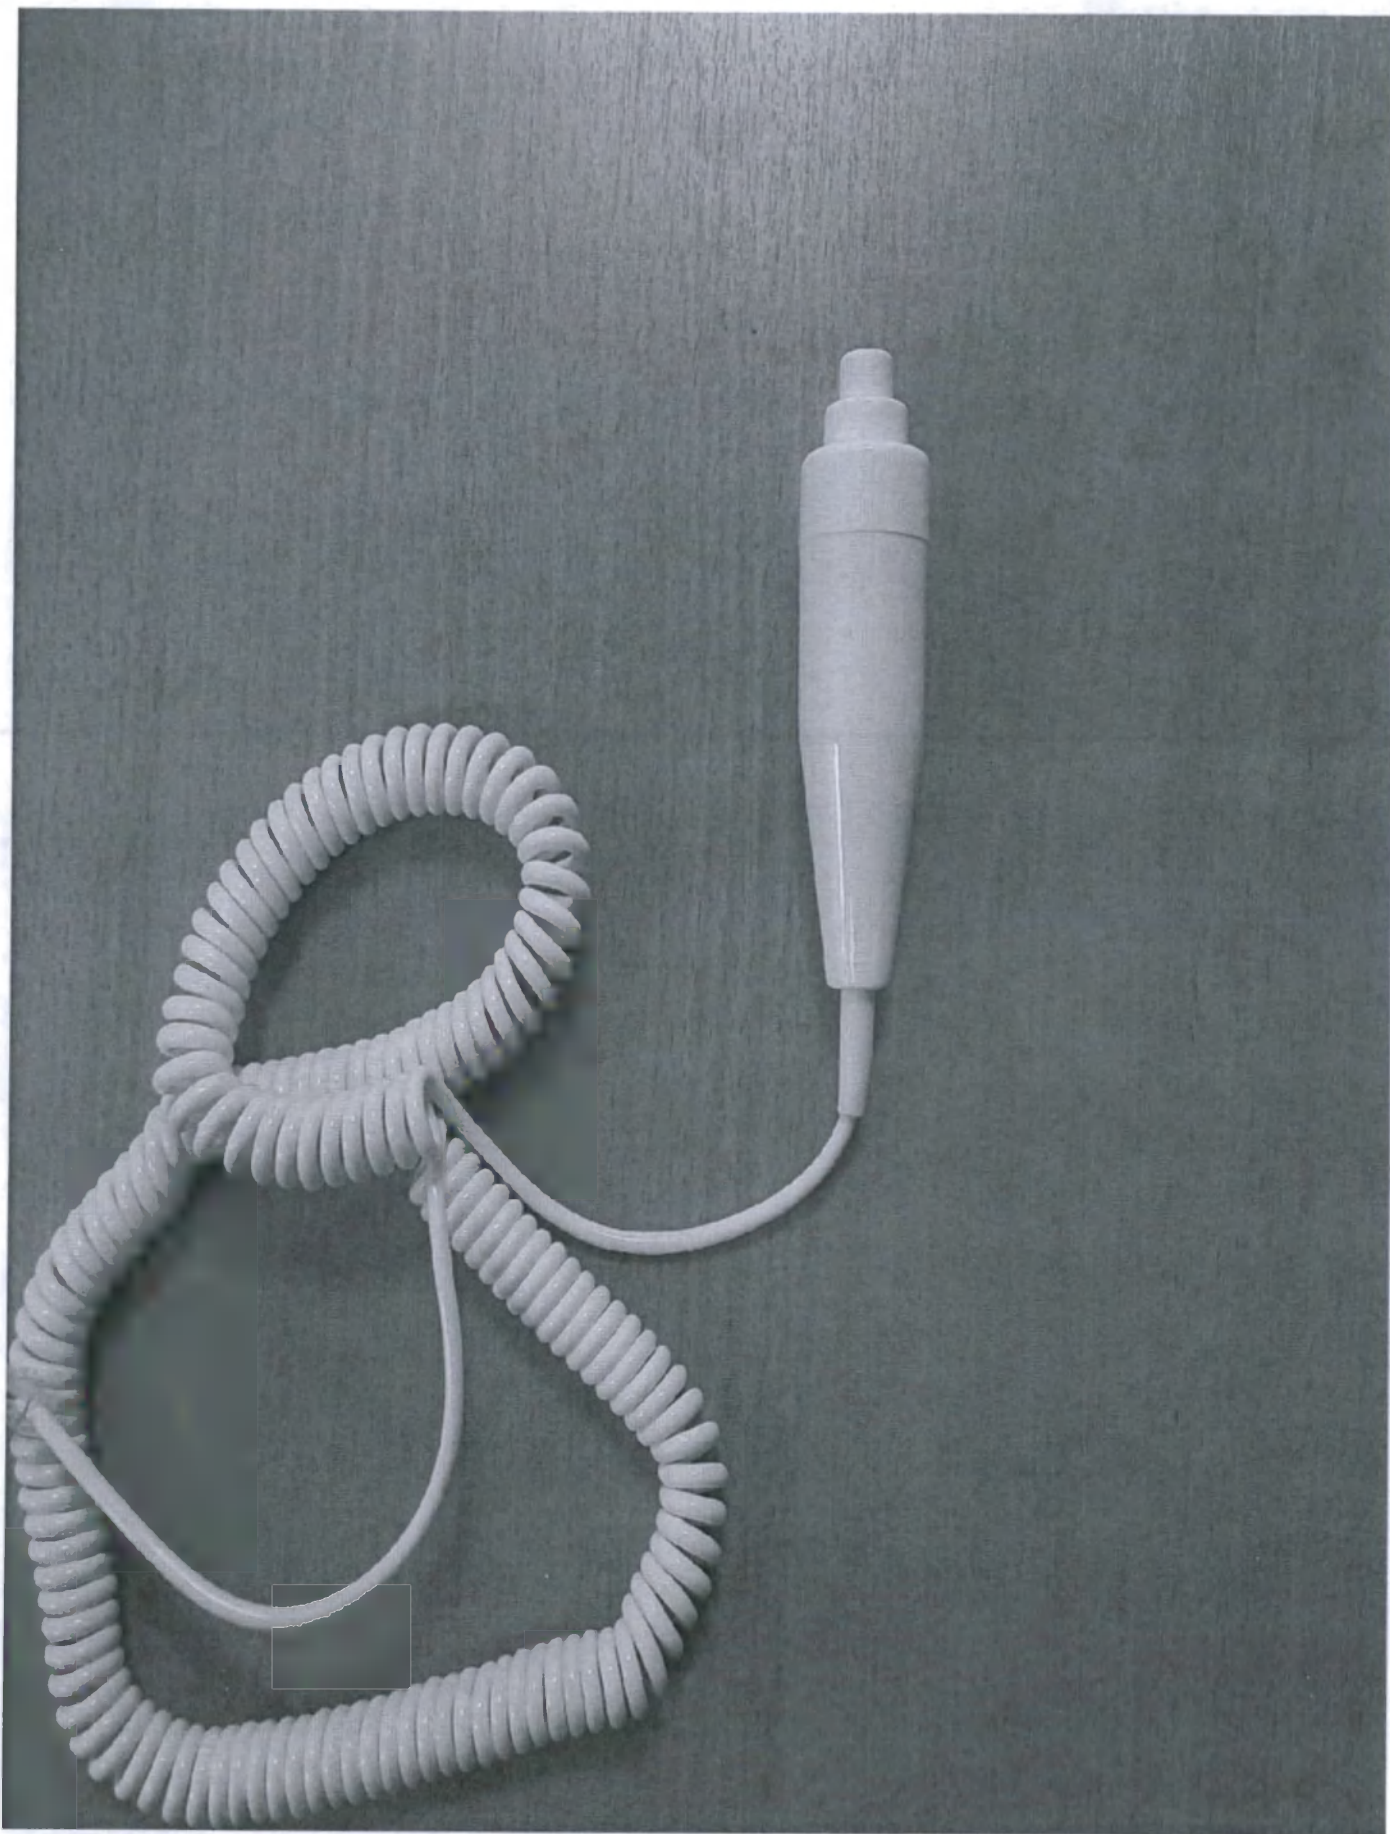


Рис 20. - Выносная кнопка экспозиции

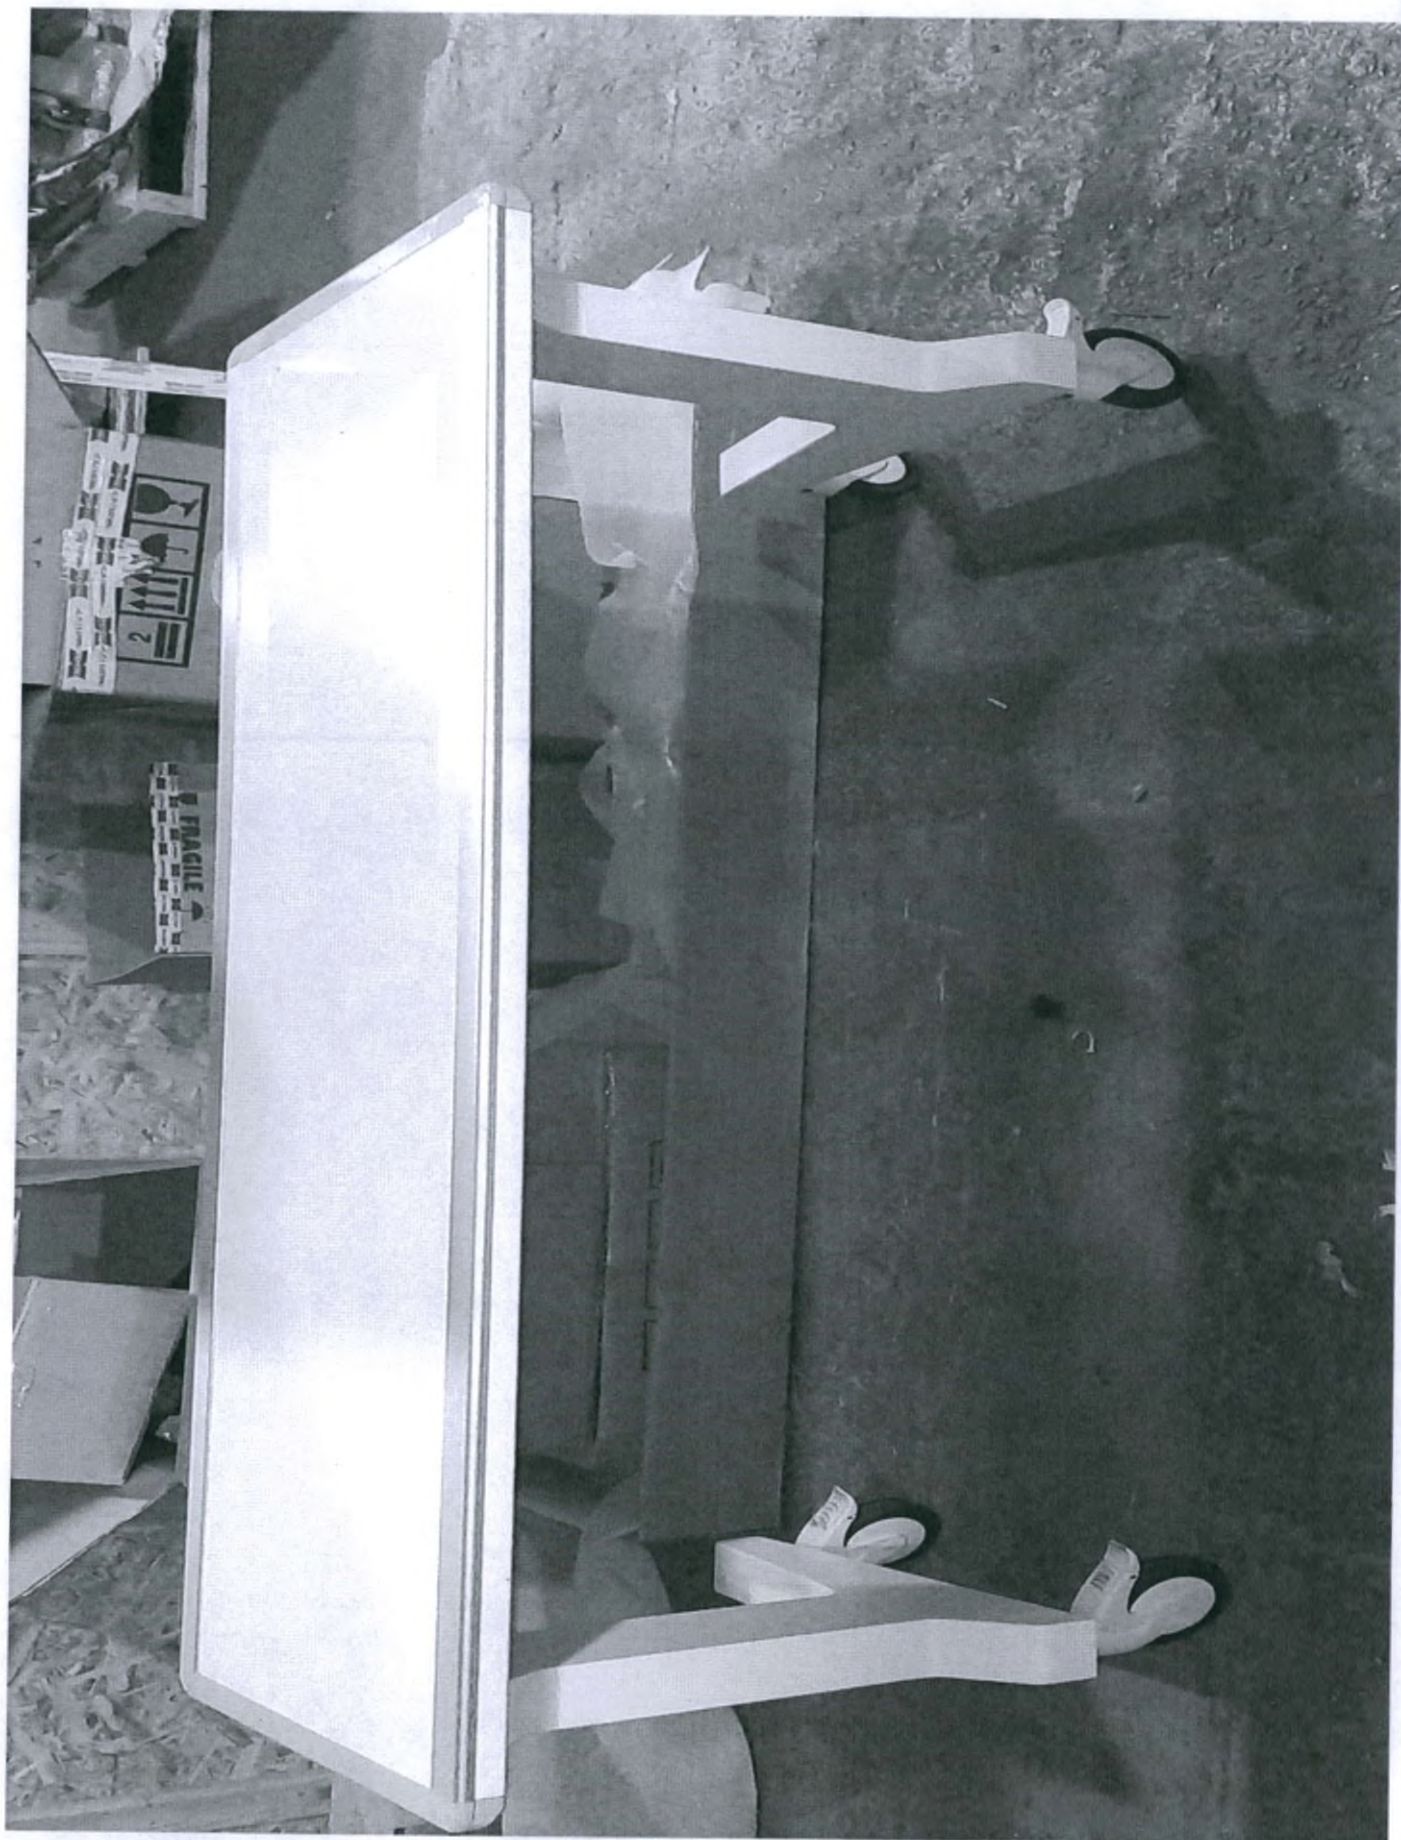


Рис 21. - Стол-каталка ЛЖКМ.943129.060

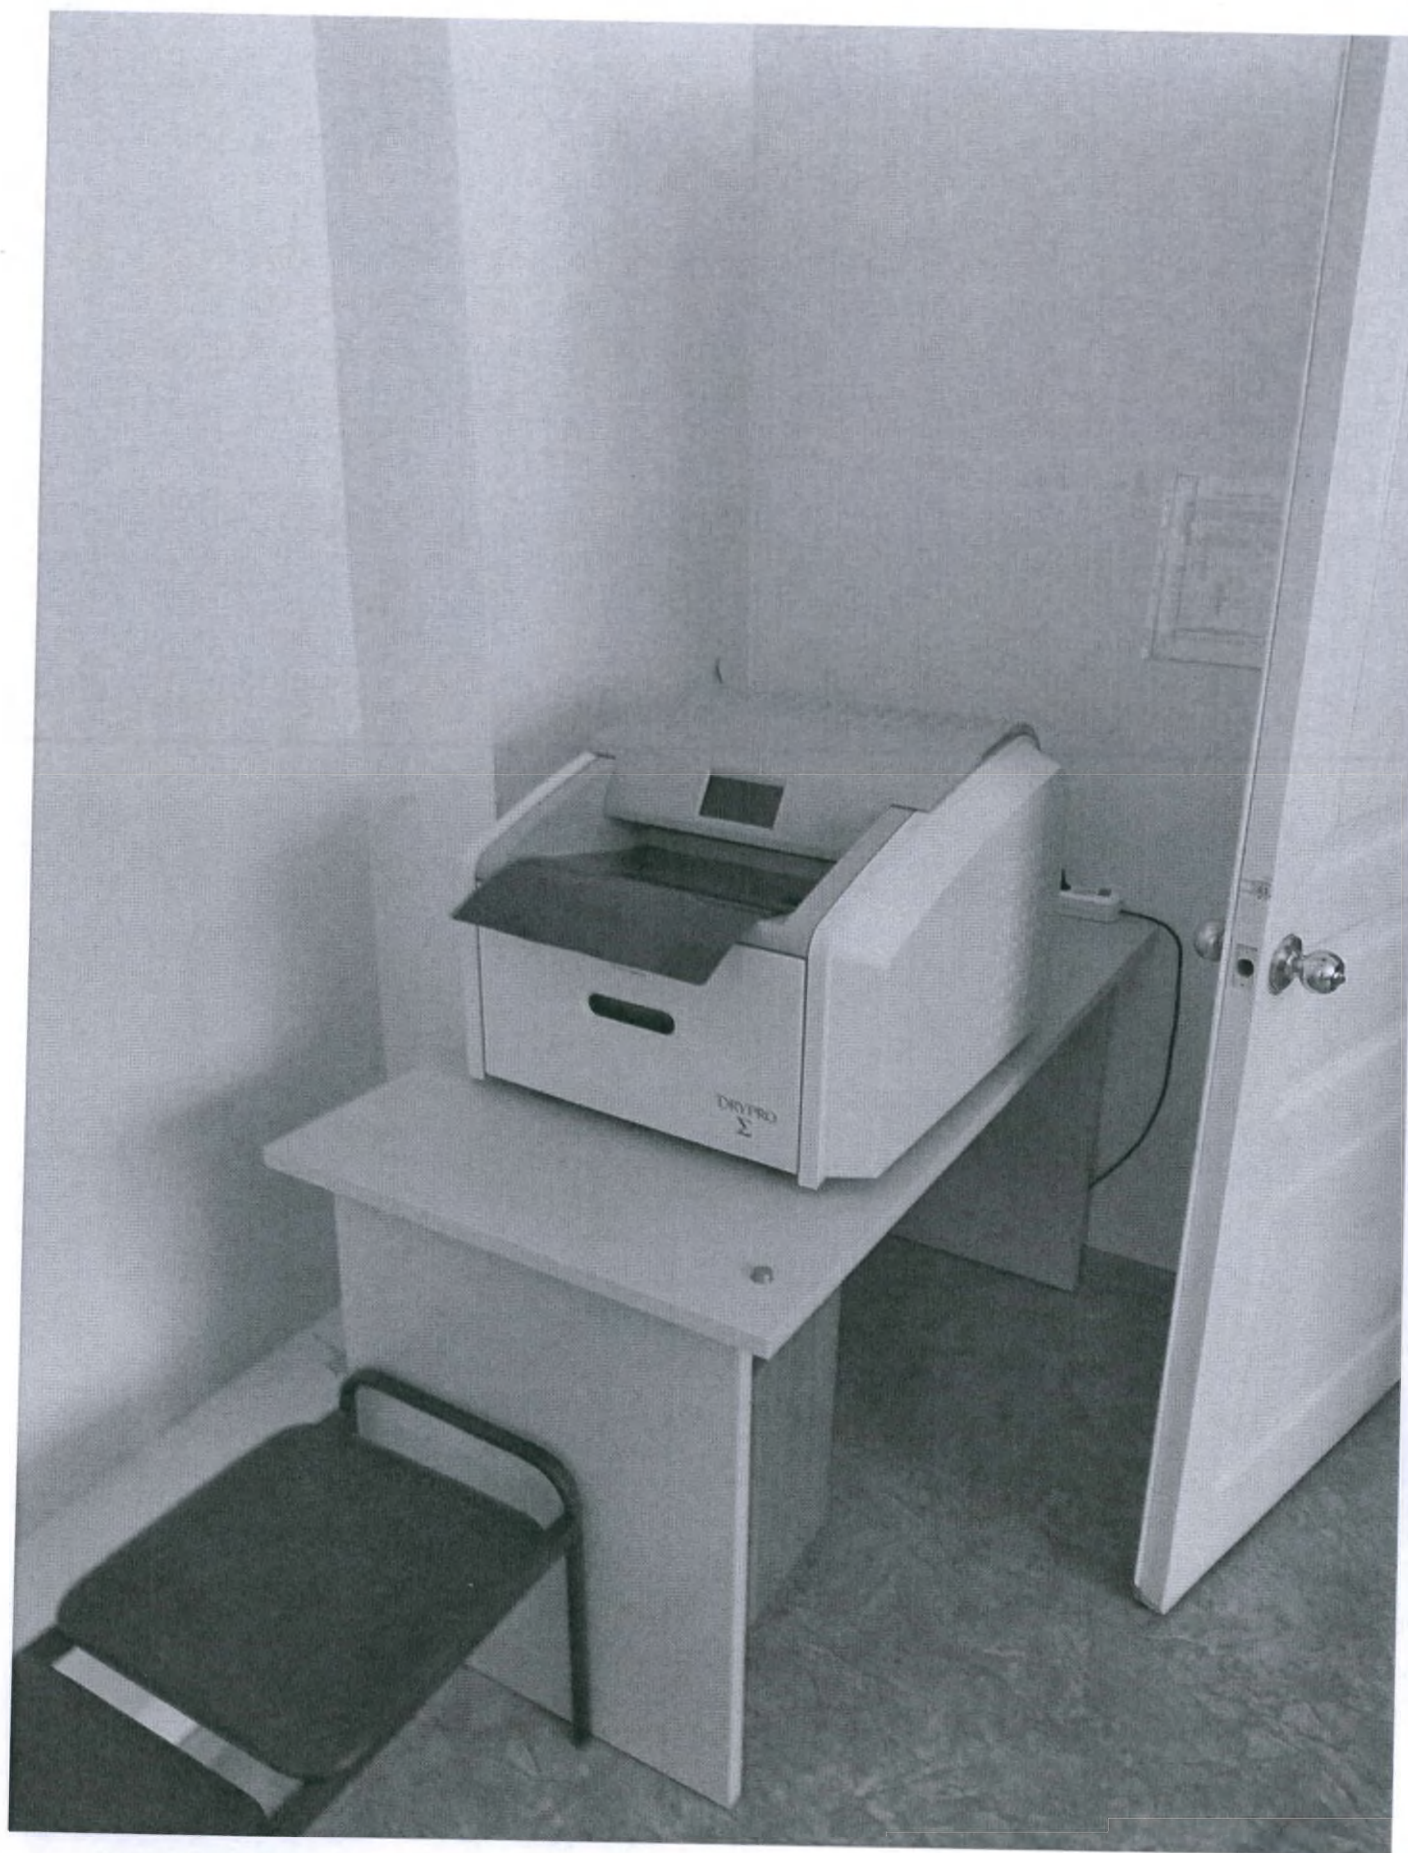


Рис 22. - Камера лазерная мультимедийная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями, РУ №ФСЗ 2012/12920,



Рис 23. - камера мультиформатная термографическая с принадлежностями Drystar AXYS, РУ № ФСЗ 2008/01838,

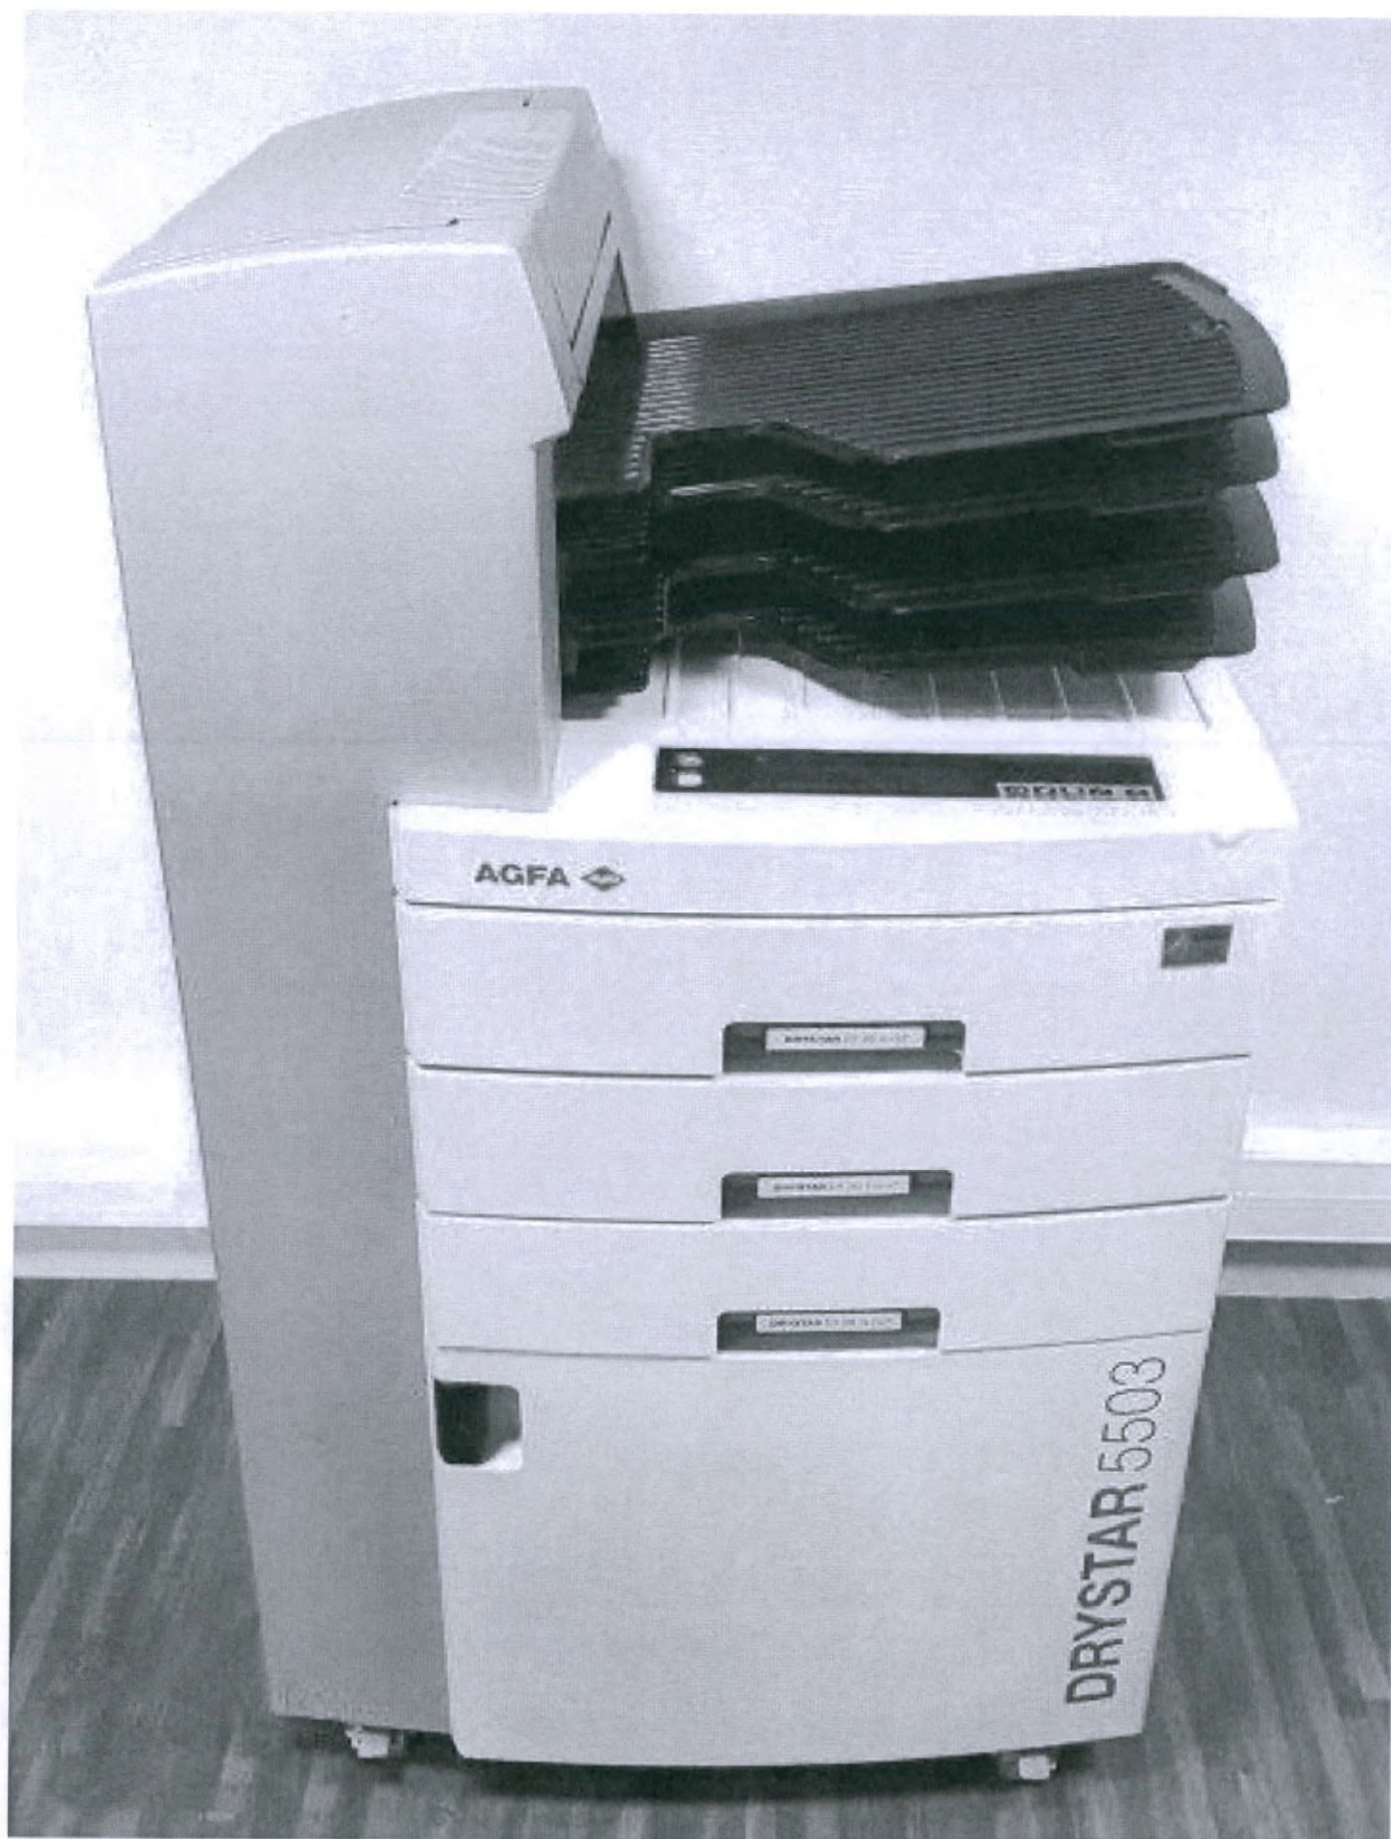


Рис 24. - камера мультиформатная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2008/02790,

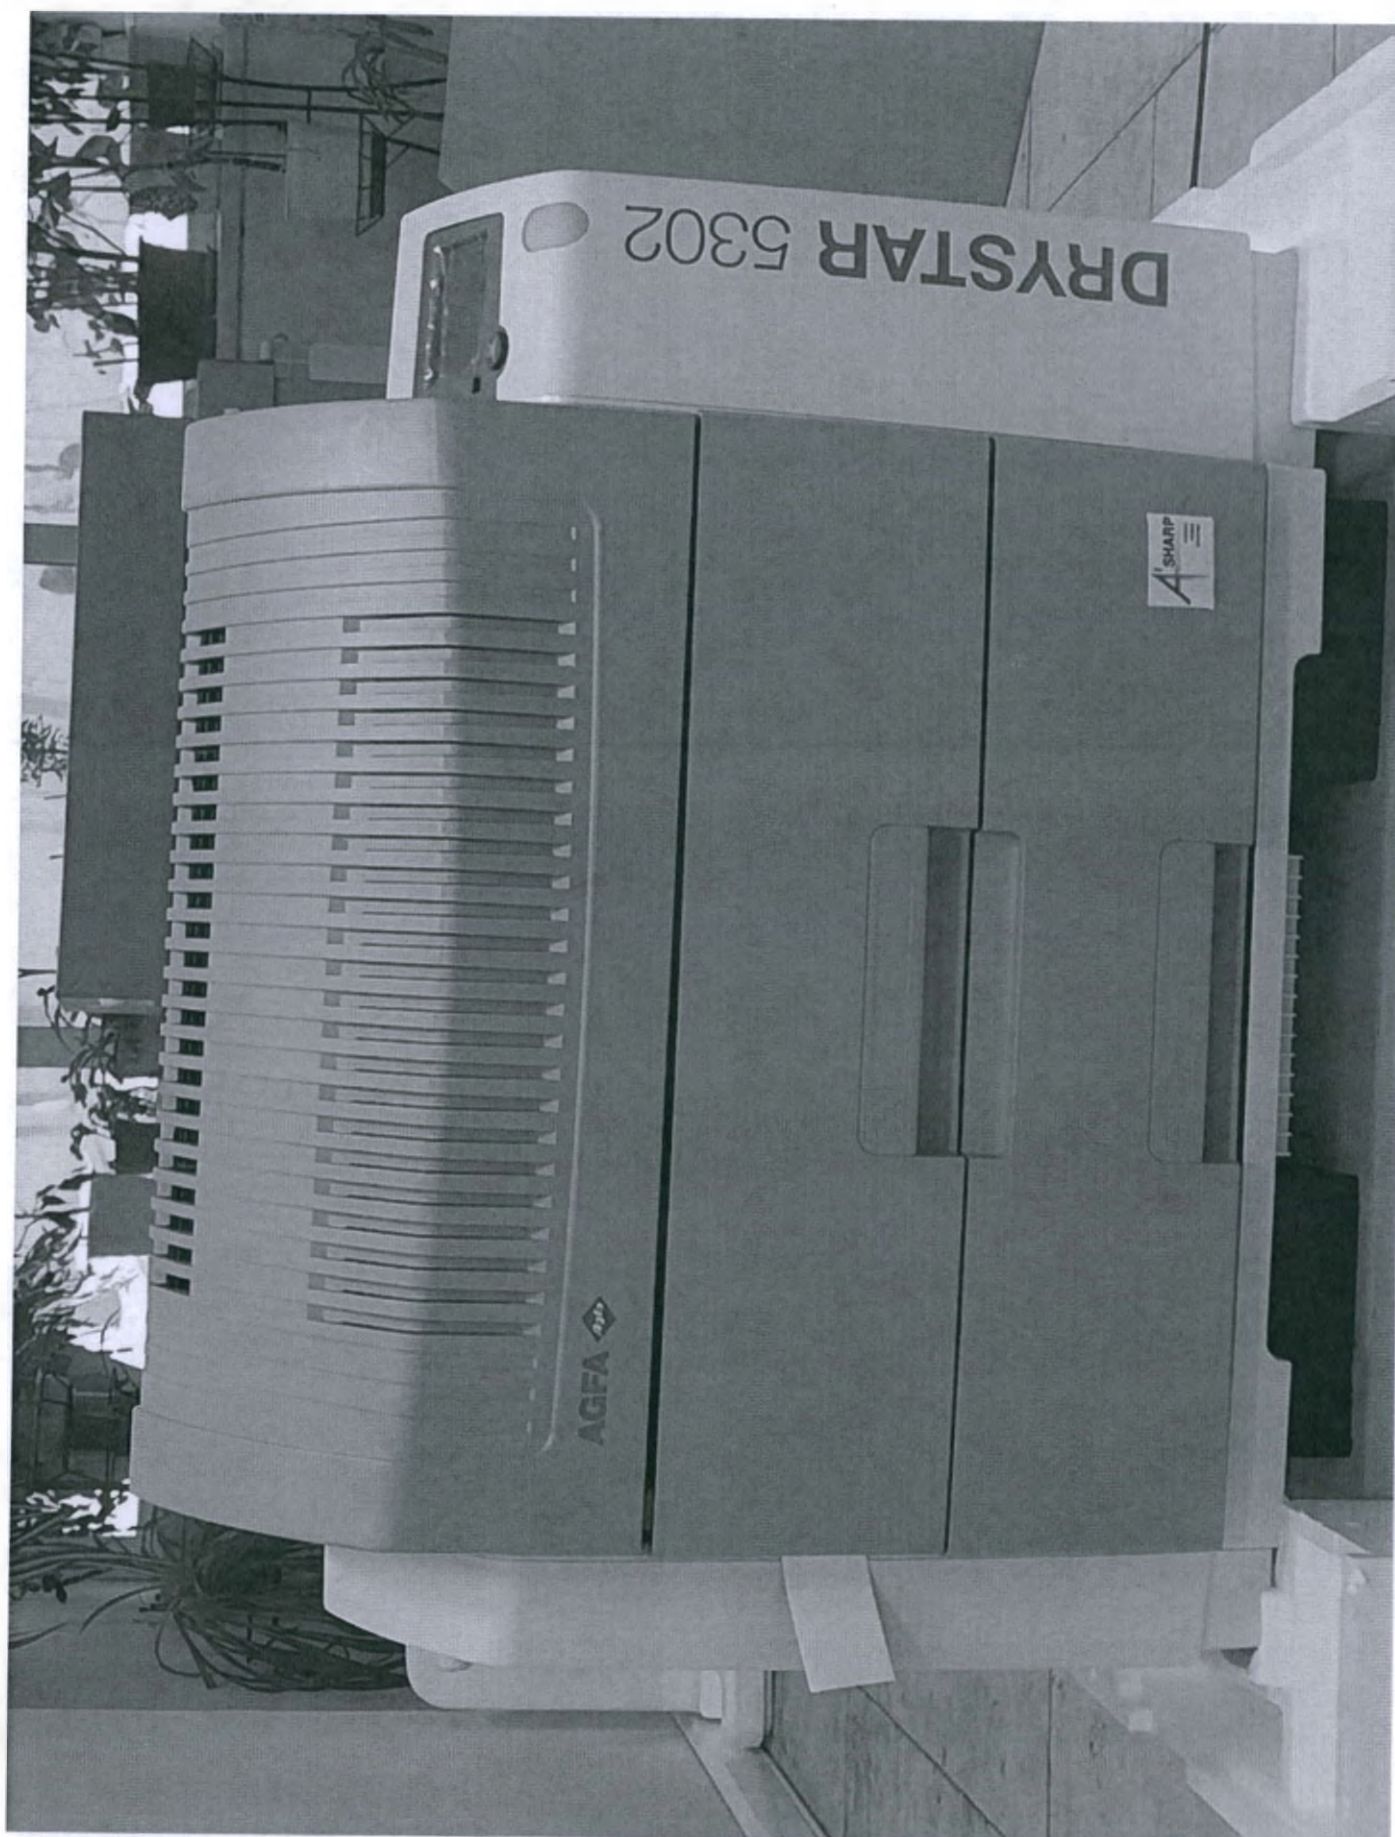


Рис 25. - камера мультиформатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2008/02792,



Рис 26. - камера медицинская лазерная мультiformатная DRYPIX 4000
исполнения DRYPIX Plus с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12949,



Рис 27. - камера лазерная мультiformатная медицинская DRYPRO, РУ № ФСЗ
2007/00692

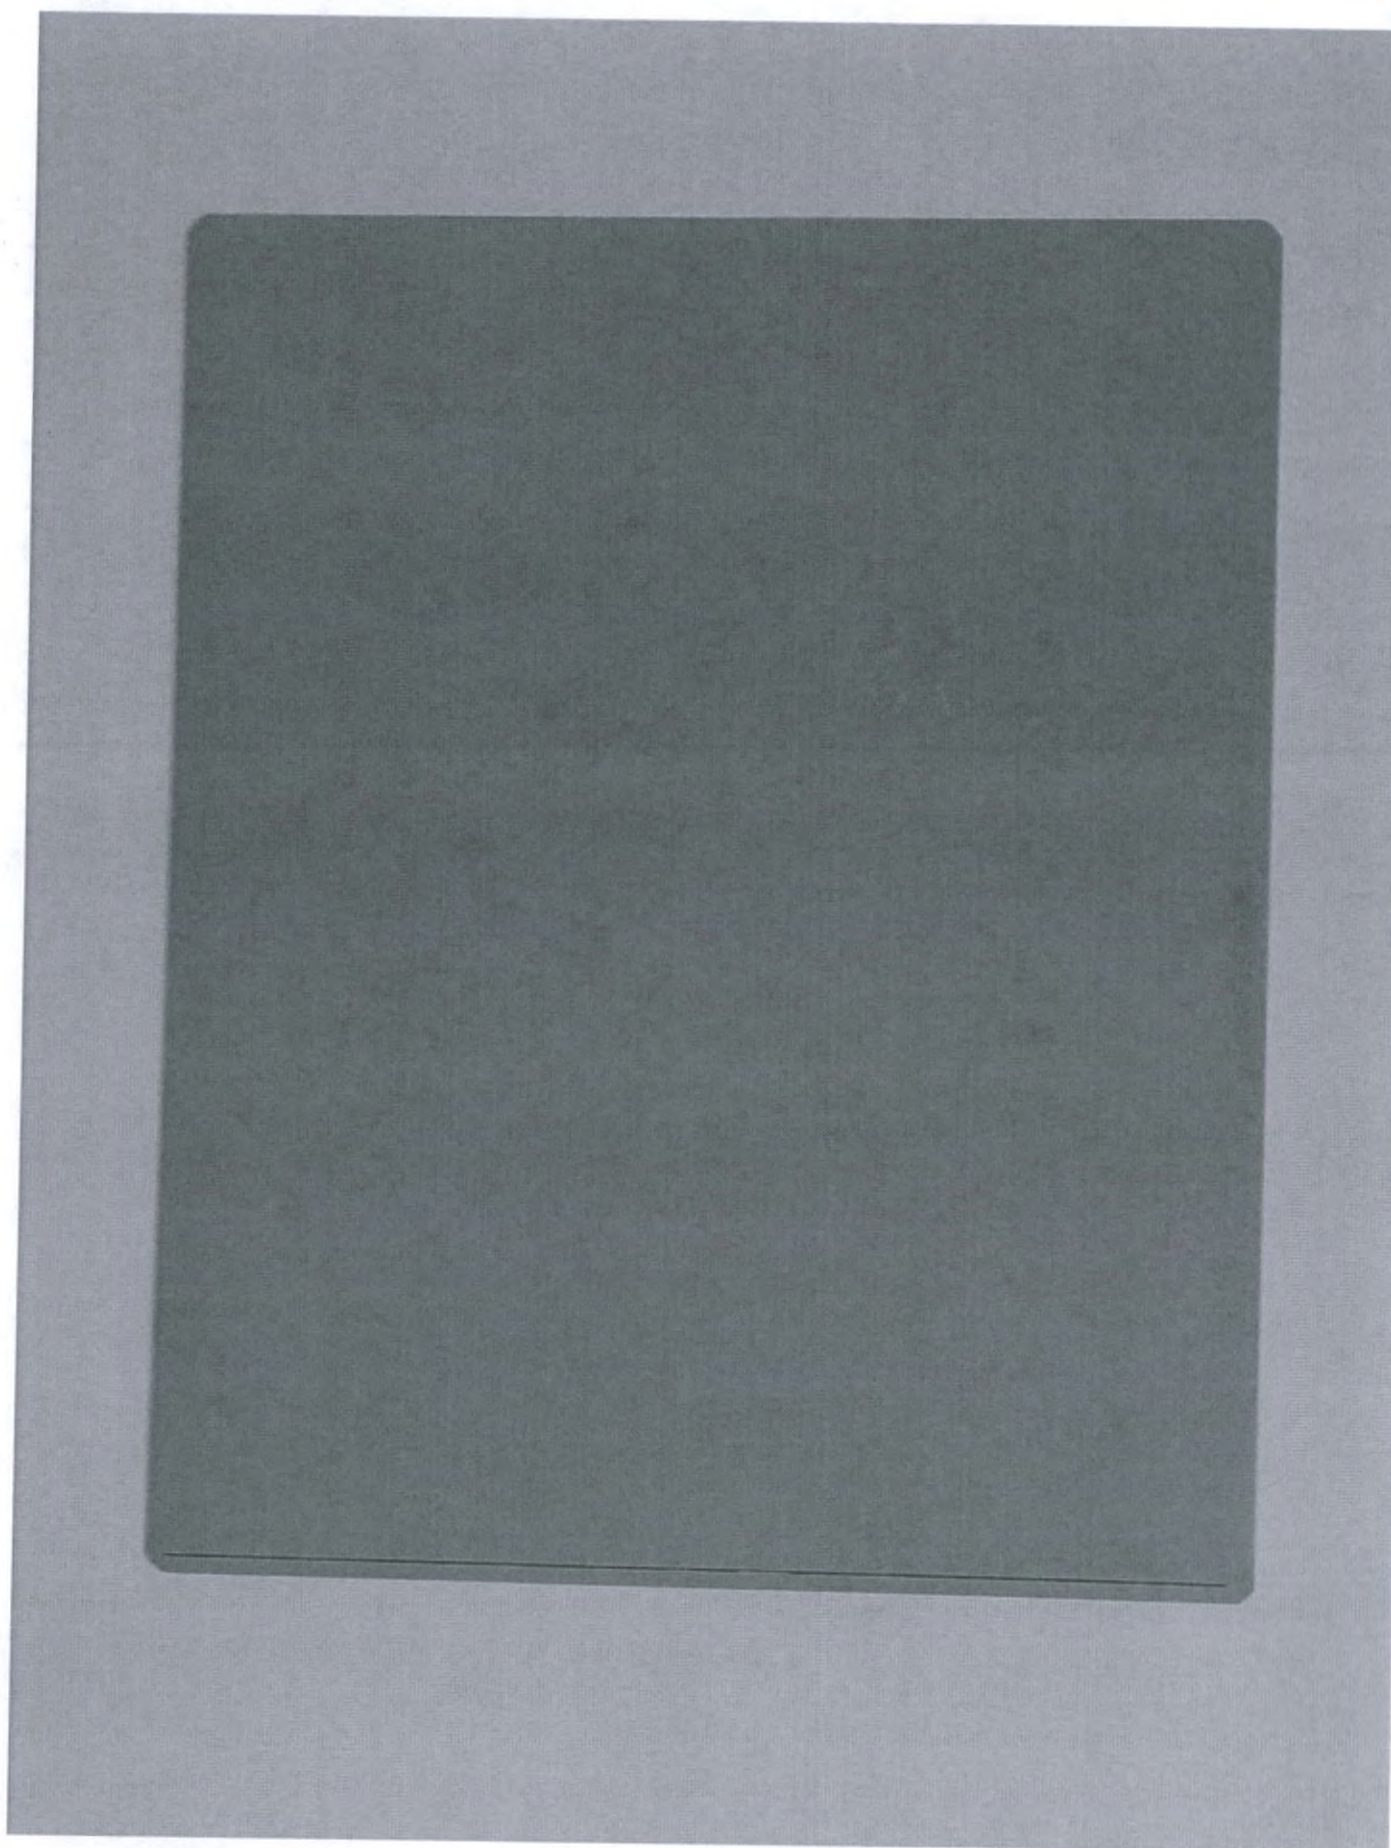


Рис 28. - Пленка медицинская термографическая и лазерная

Рис 29. - Комплект рентгеновской одежды для пациентов и персонала

- Фартук защитный односторонний легкий
- Фартук защитный односторонний тяжелый
- Фартук защитный двусторонний
- Воротник защитный
- Юбка защитная
- Шапочка защитная
- Защитные пластины
- жилет рентгенозащитный
- передник рентгенозащитный детский
- юбка рентгенозащитная детская



- Фартук защитный односторонний легкий



- Фартук защитный односторонний тяжелый




- Фартук защитный двусторонний




- Воротник защитный



- Юбка защитная

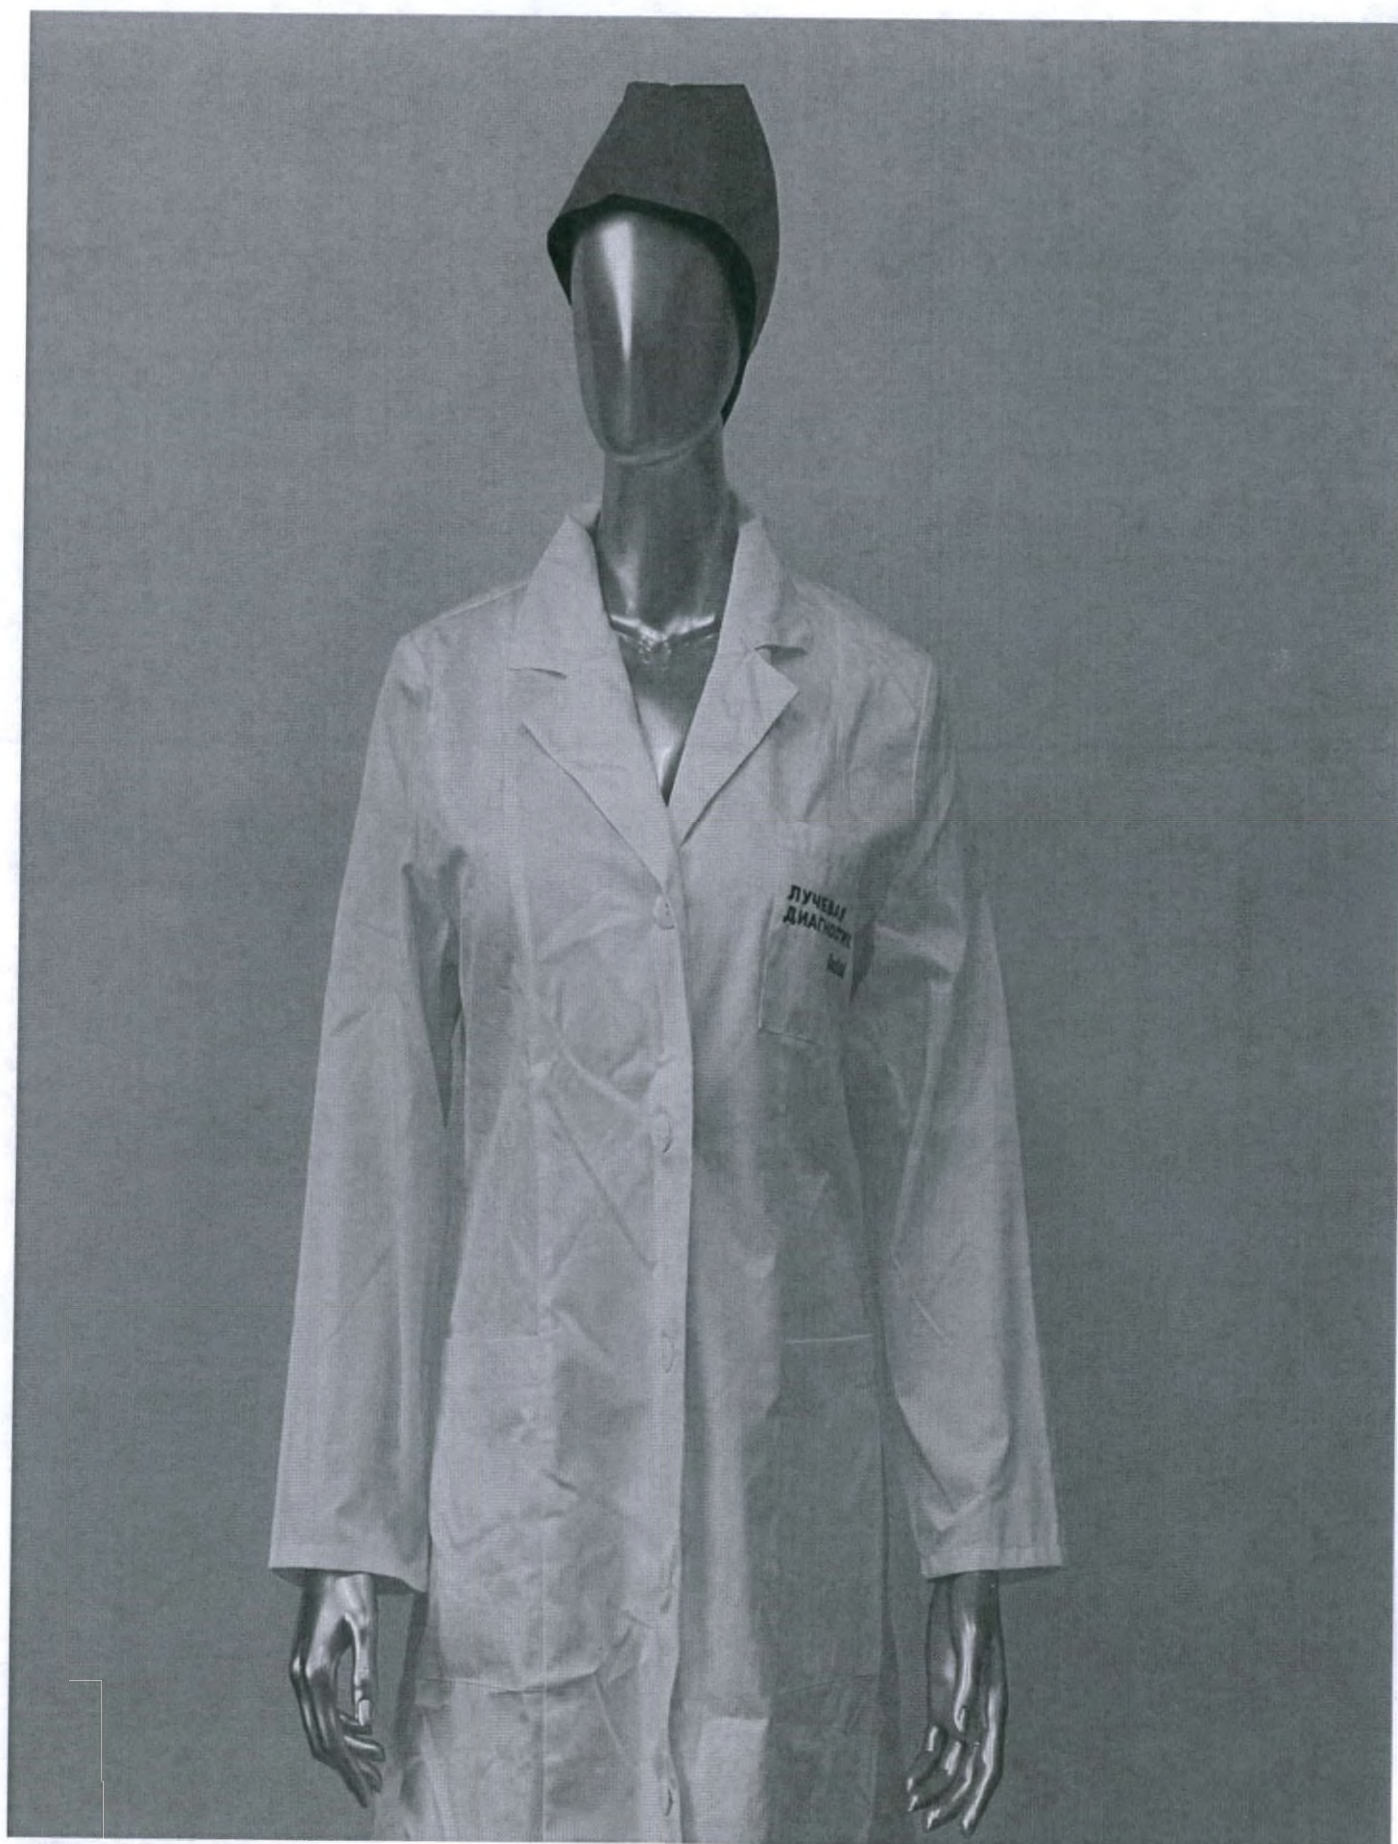

- Шапочка защитная

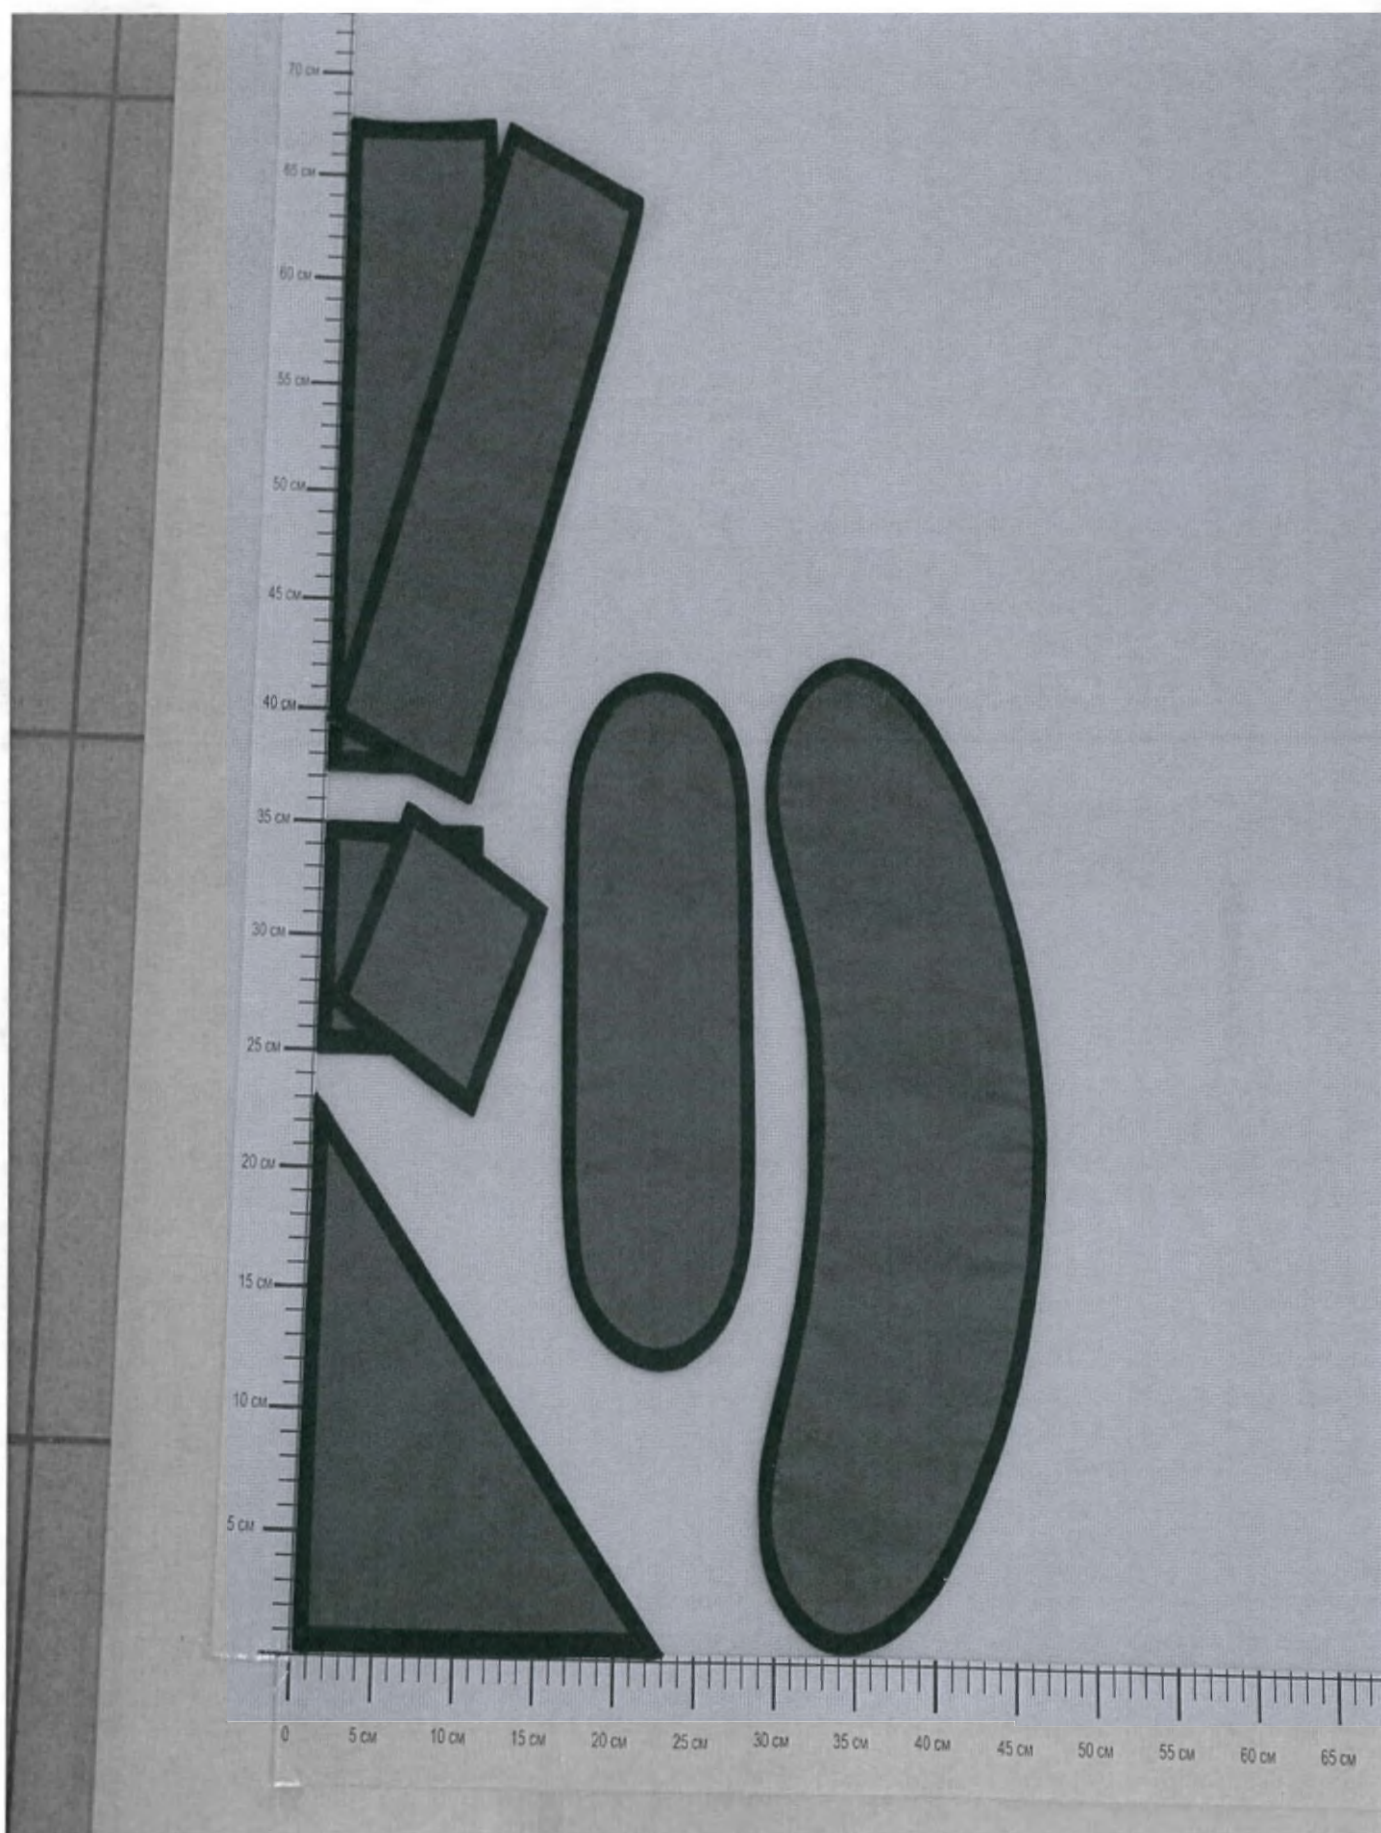


- Защитные пластины



- жилет рентгенозащитный



- передник рентгенозащитный детский

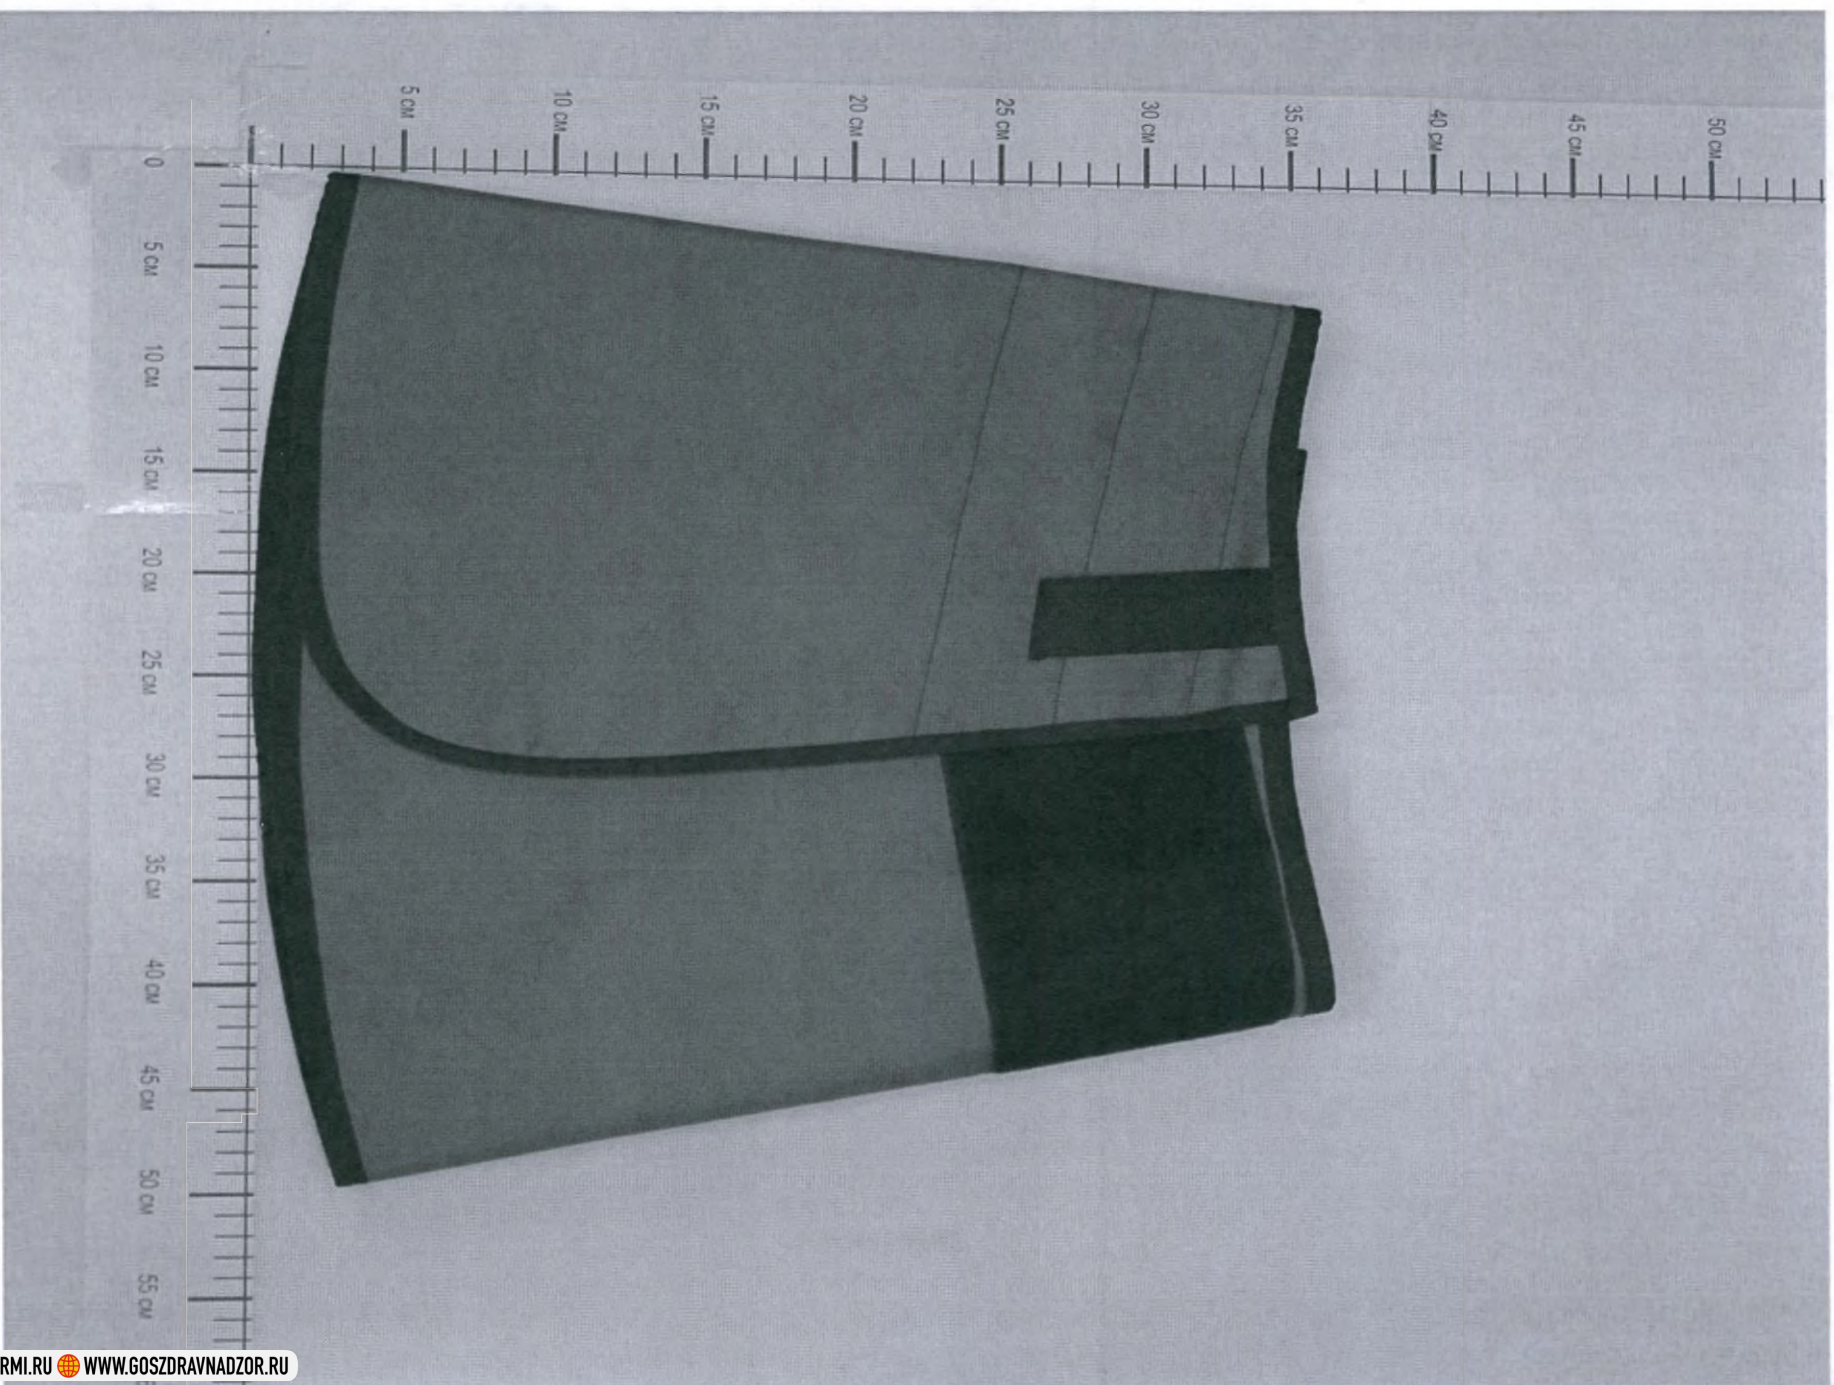

- юбка рентгенозащитная детская

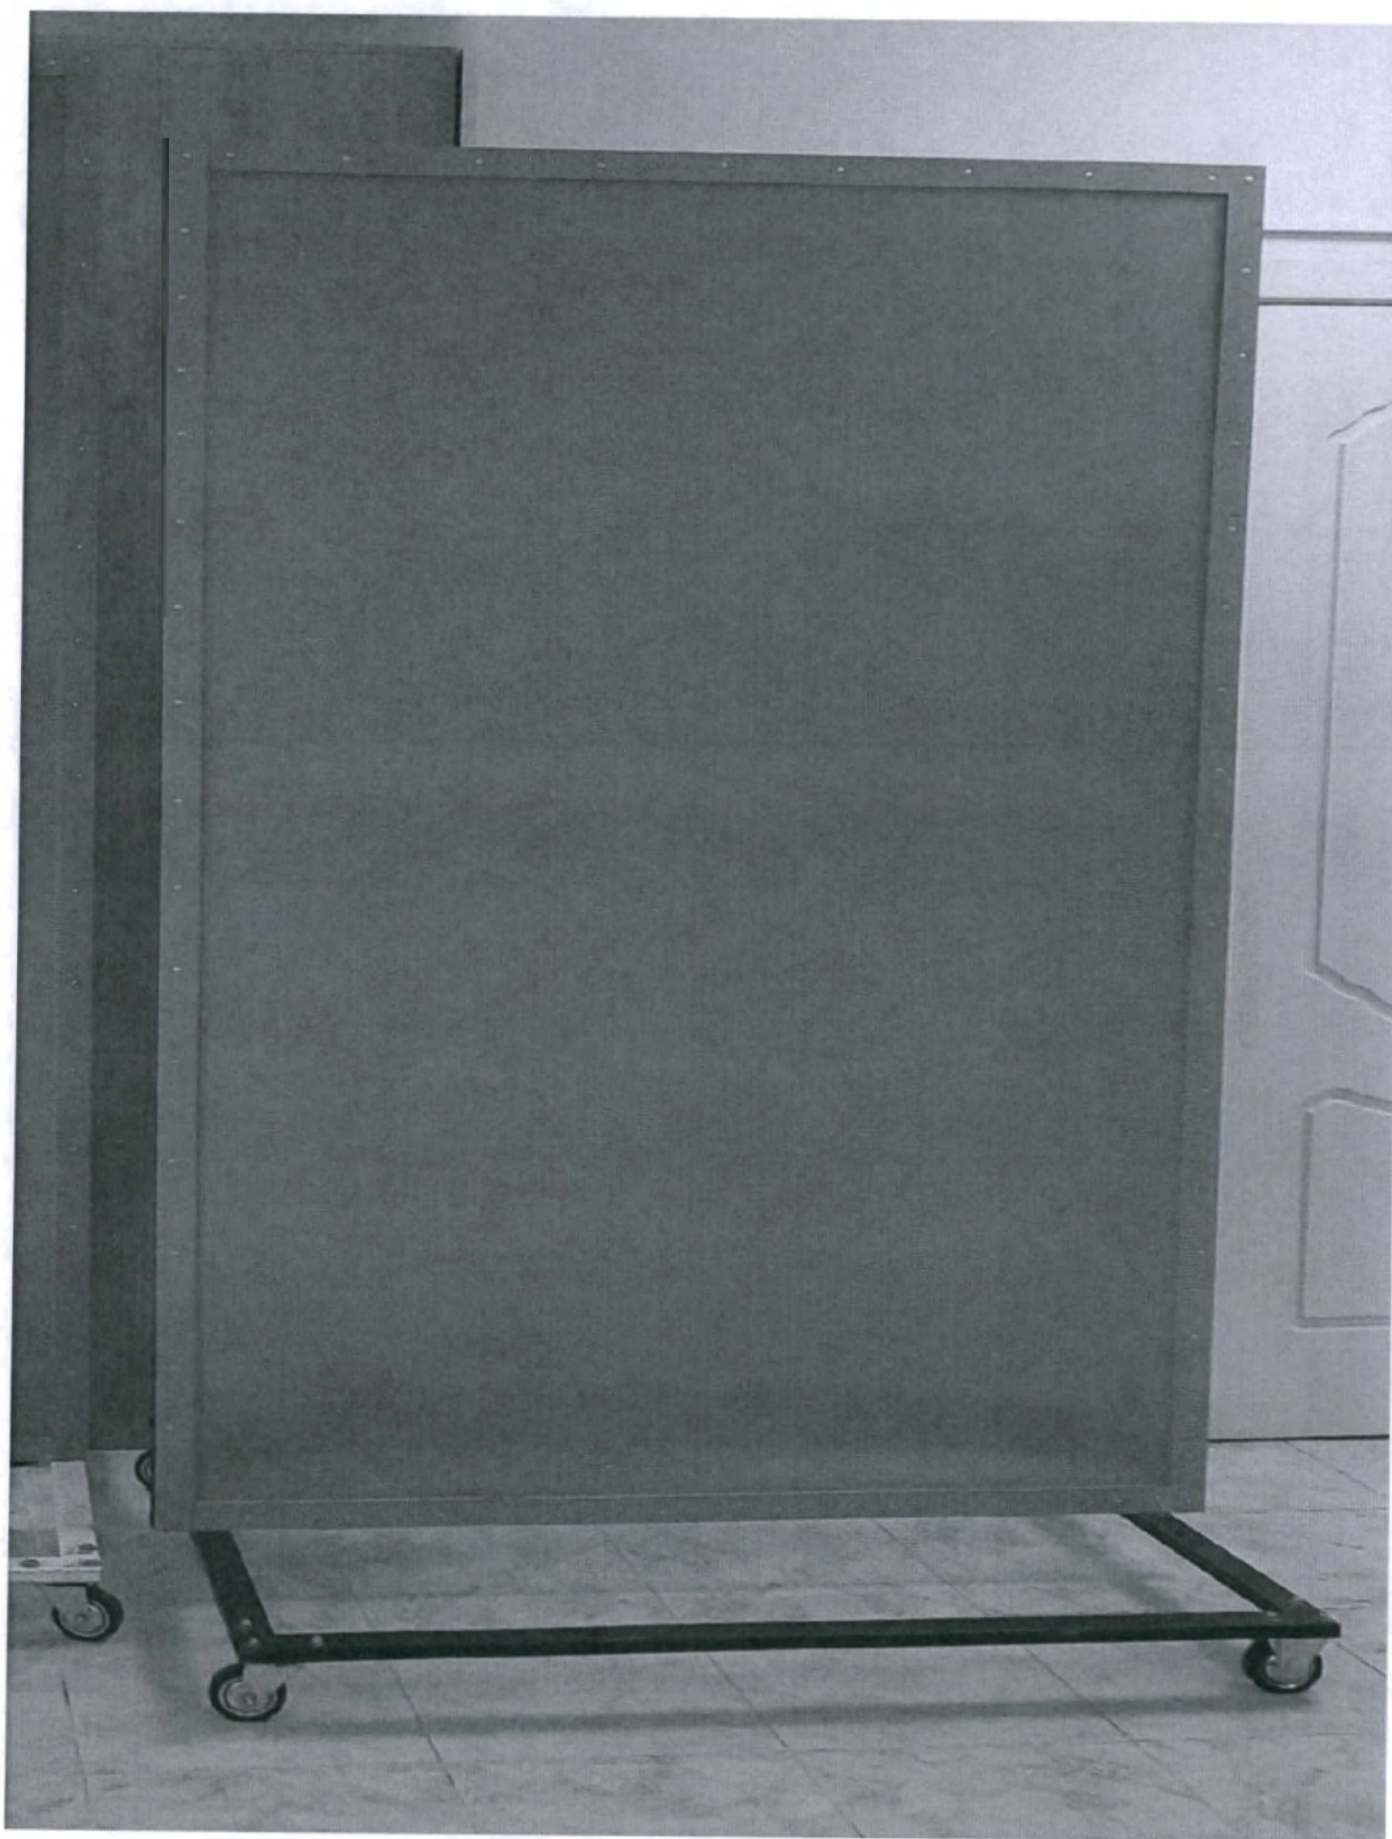


Рис 30. - Ширмы рентгенозащитные



Рис 31. - Переговорное устройство

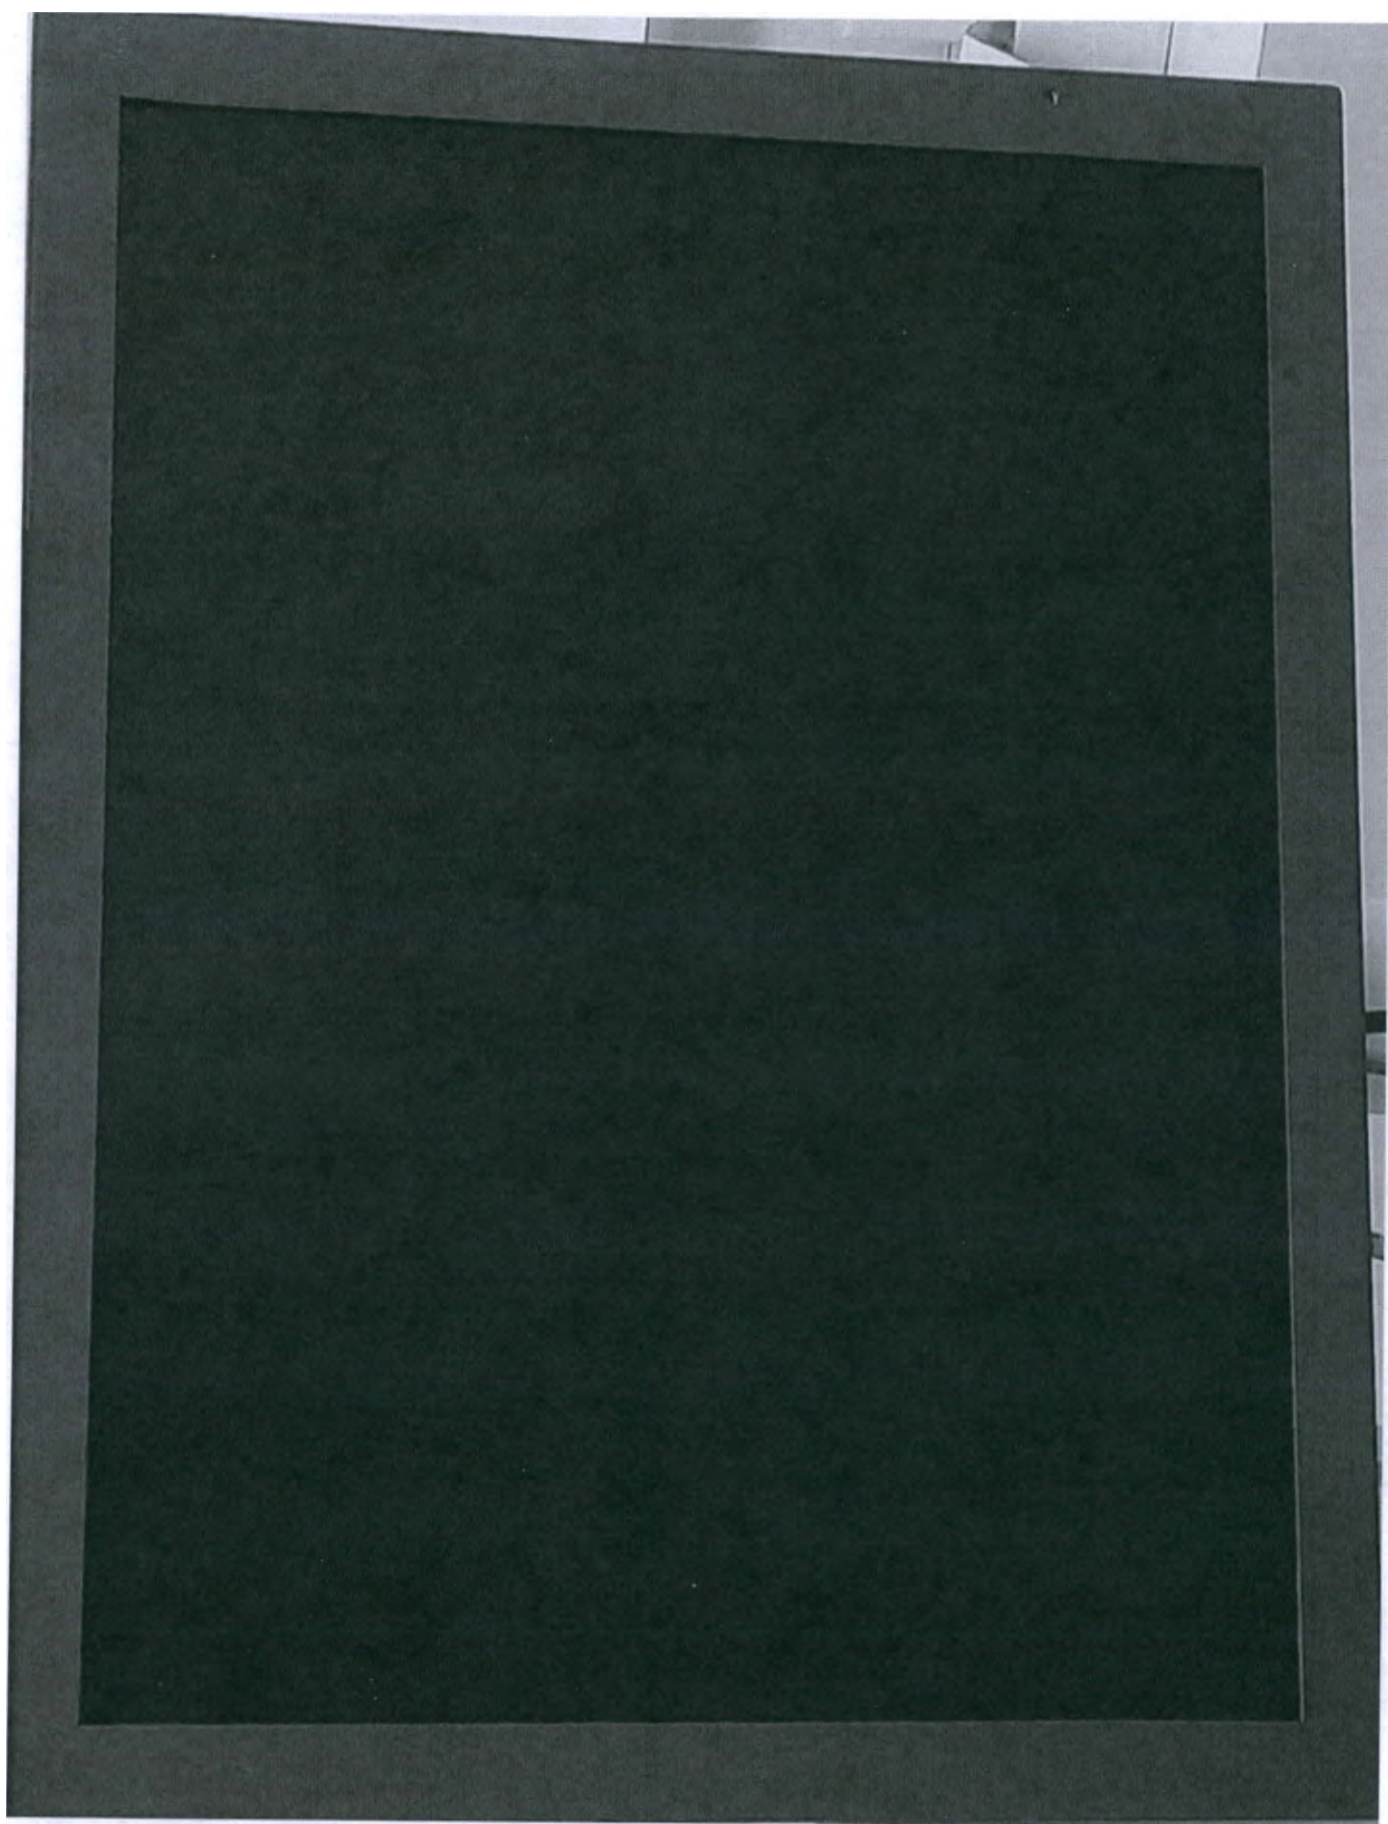


Рис 32. - Монитор медицинский монохромный

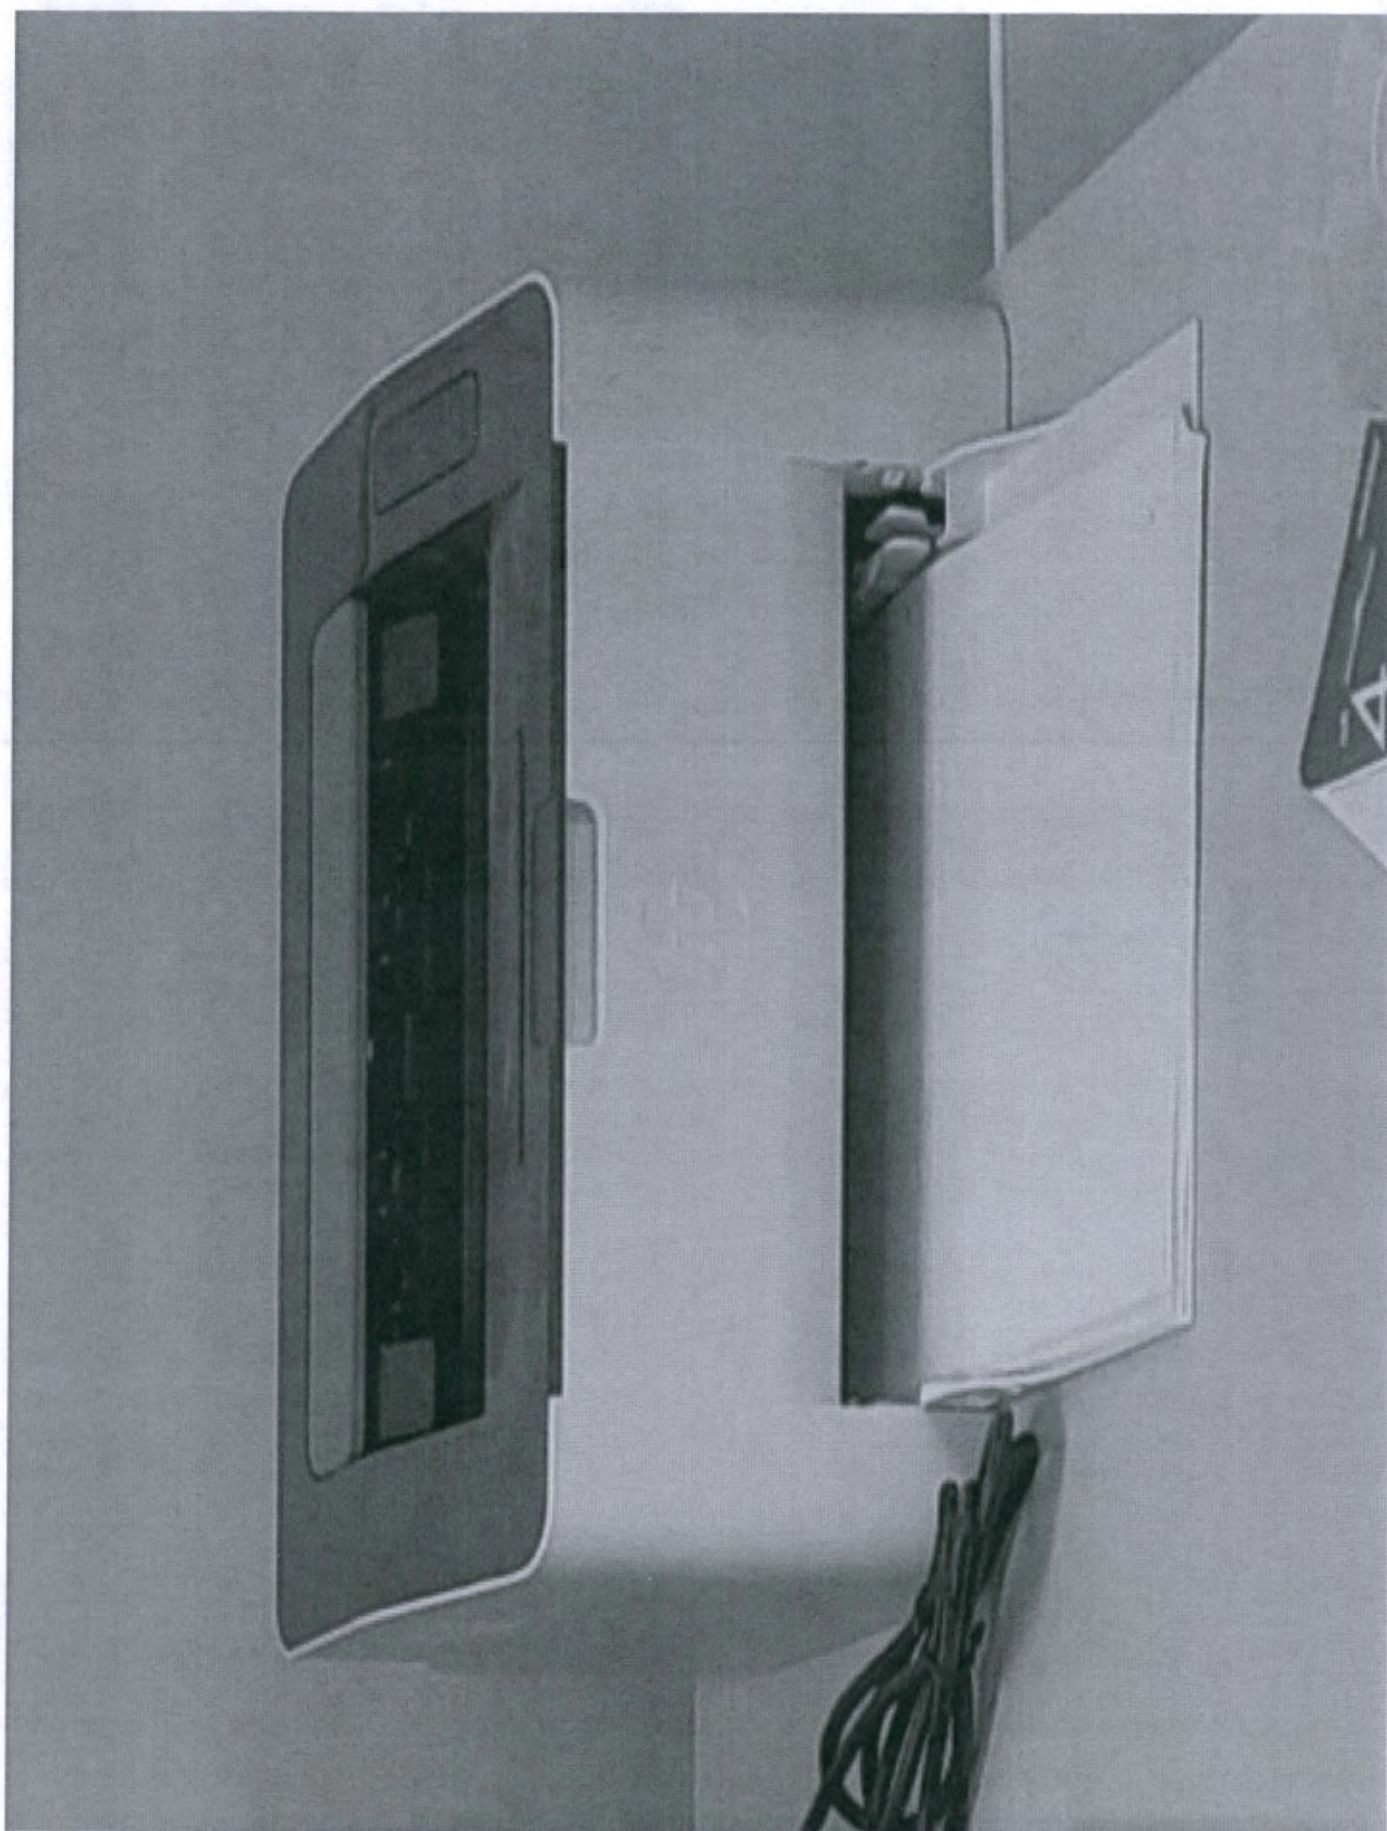


Рис 33. - Принтер лазерный

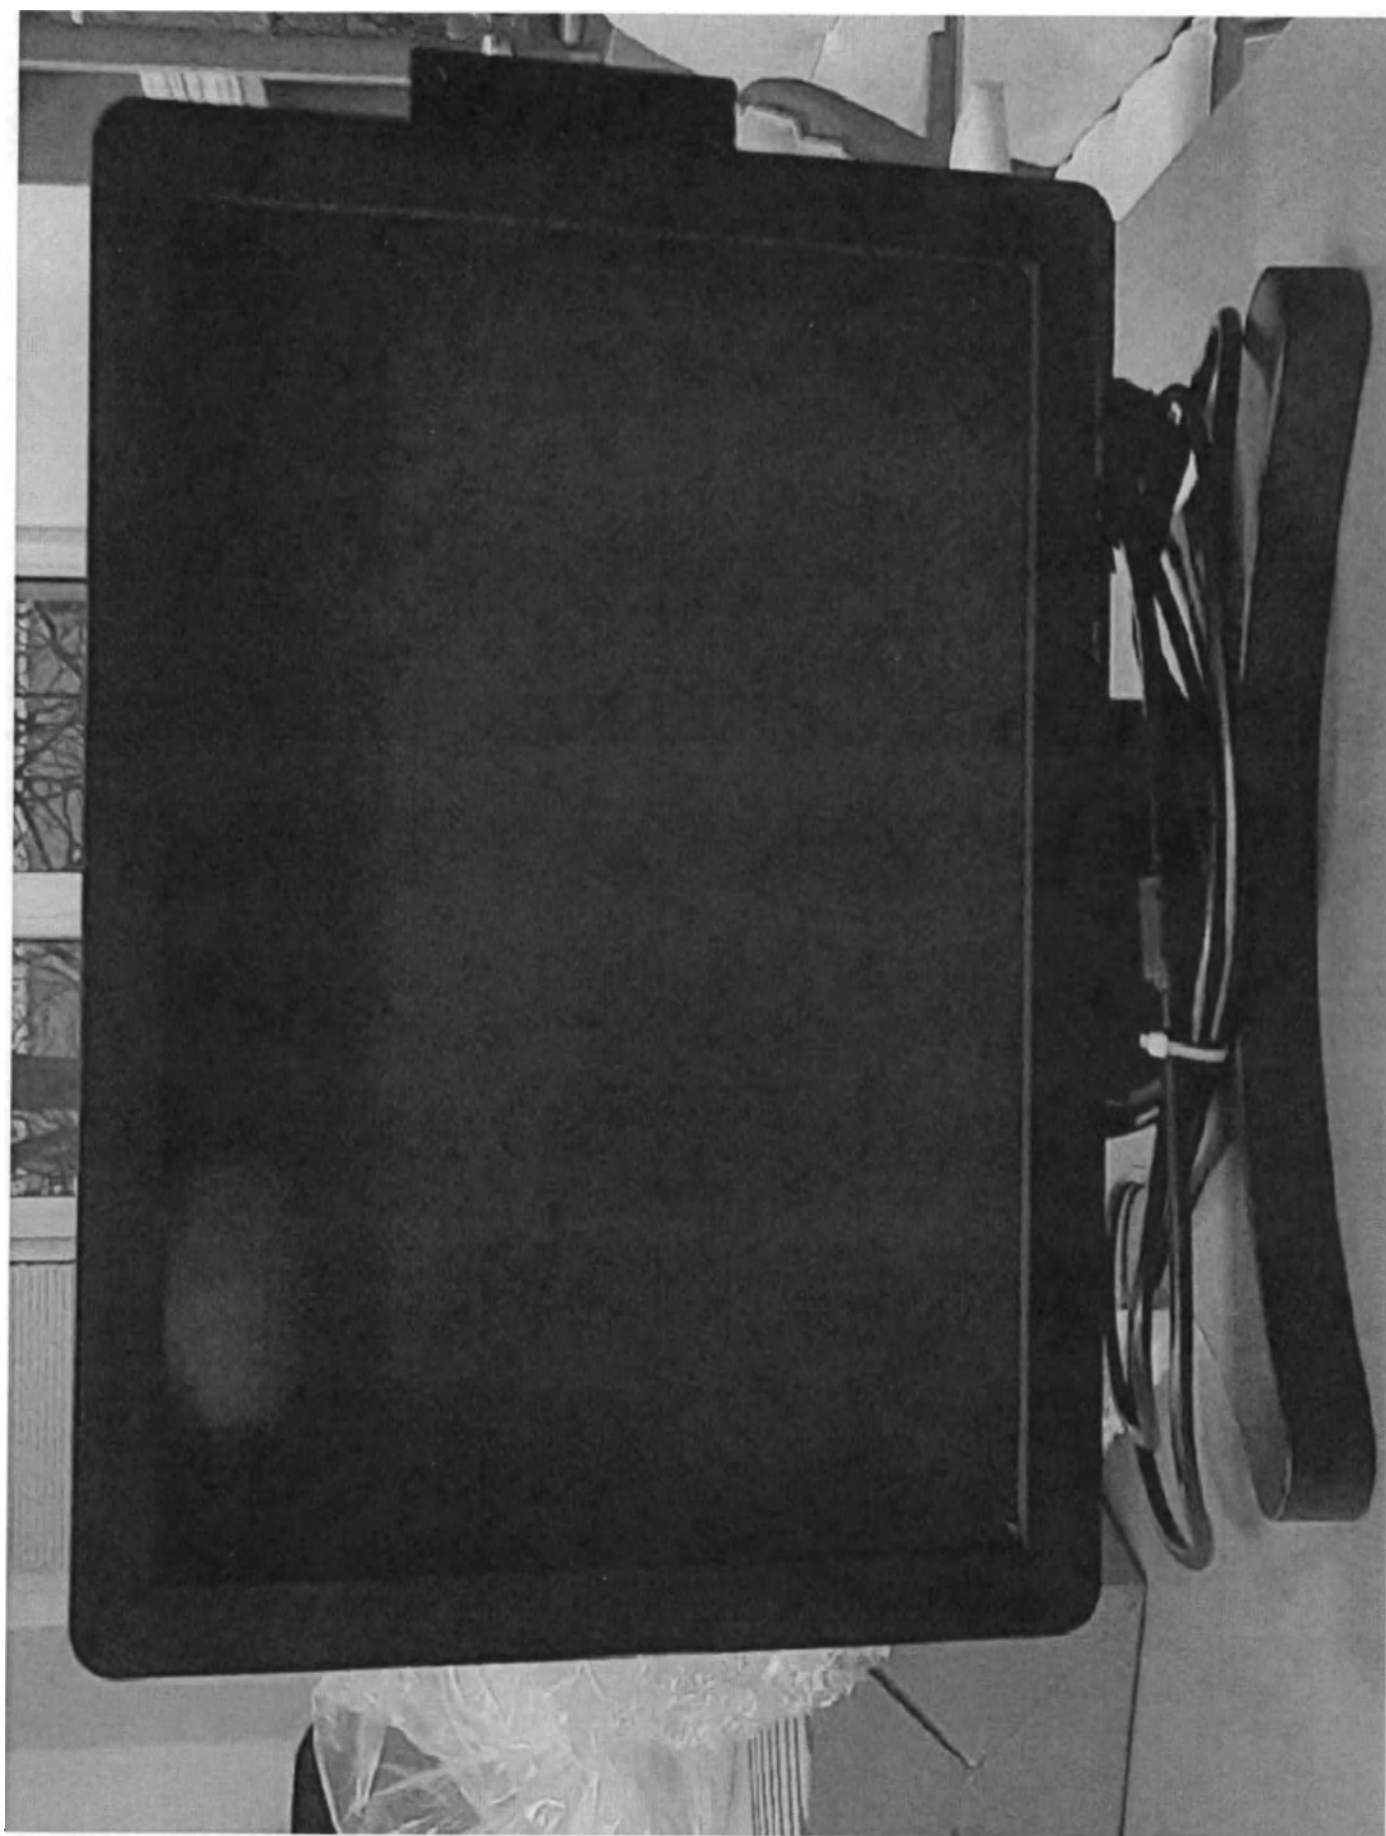


Рис 34. - Панель управления экспозицией



Рис 35. - Система видеонаблюдения

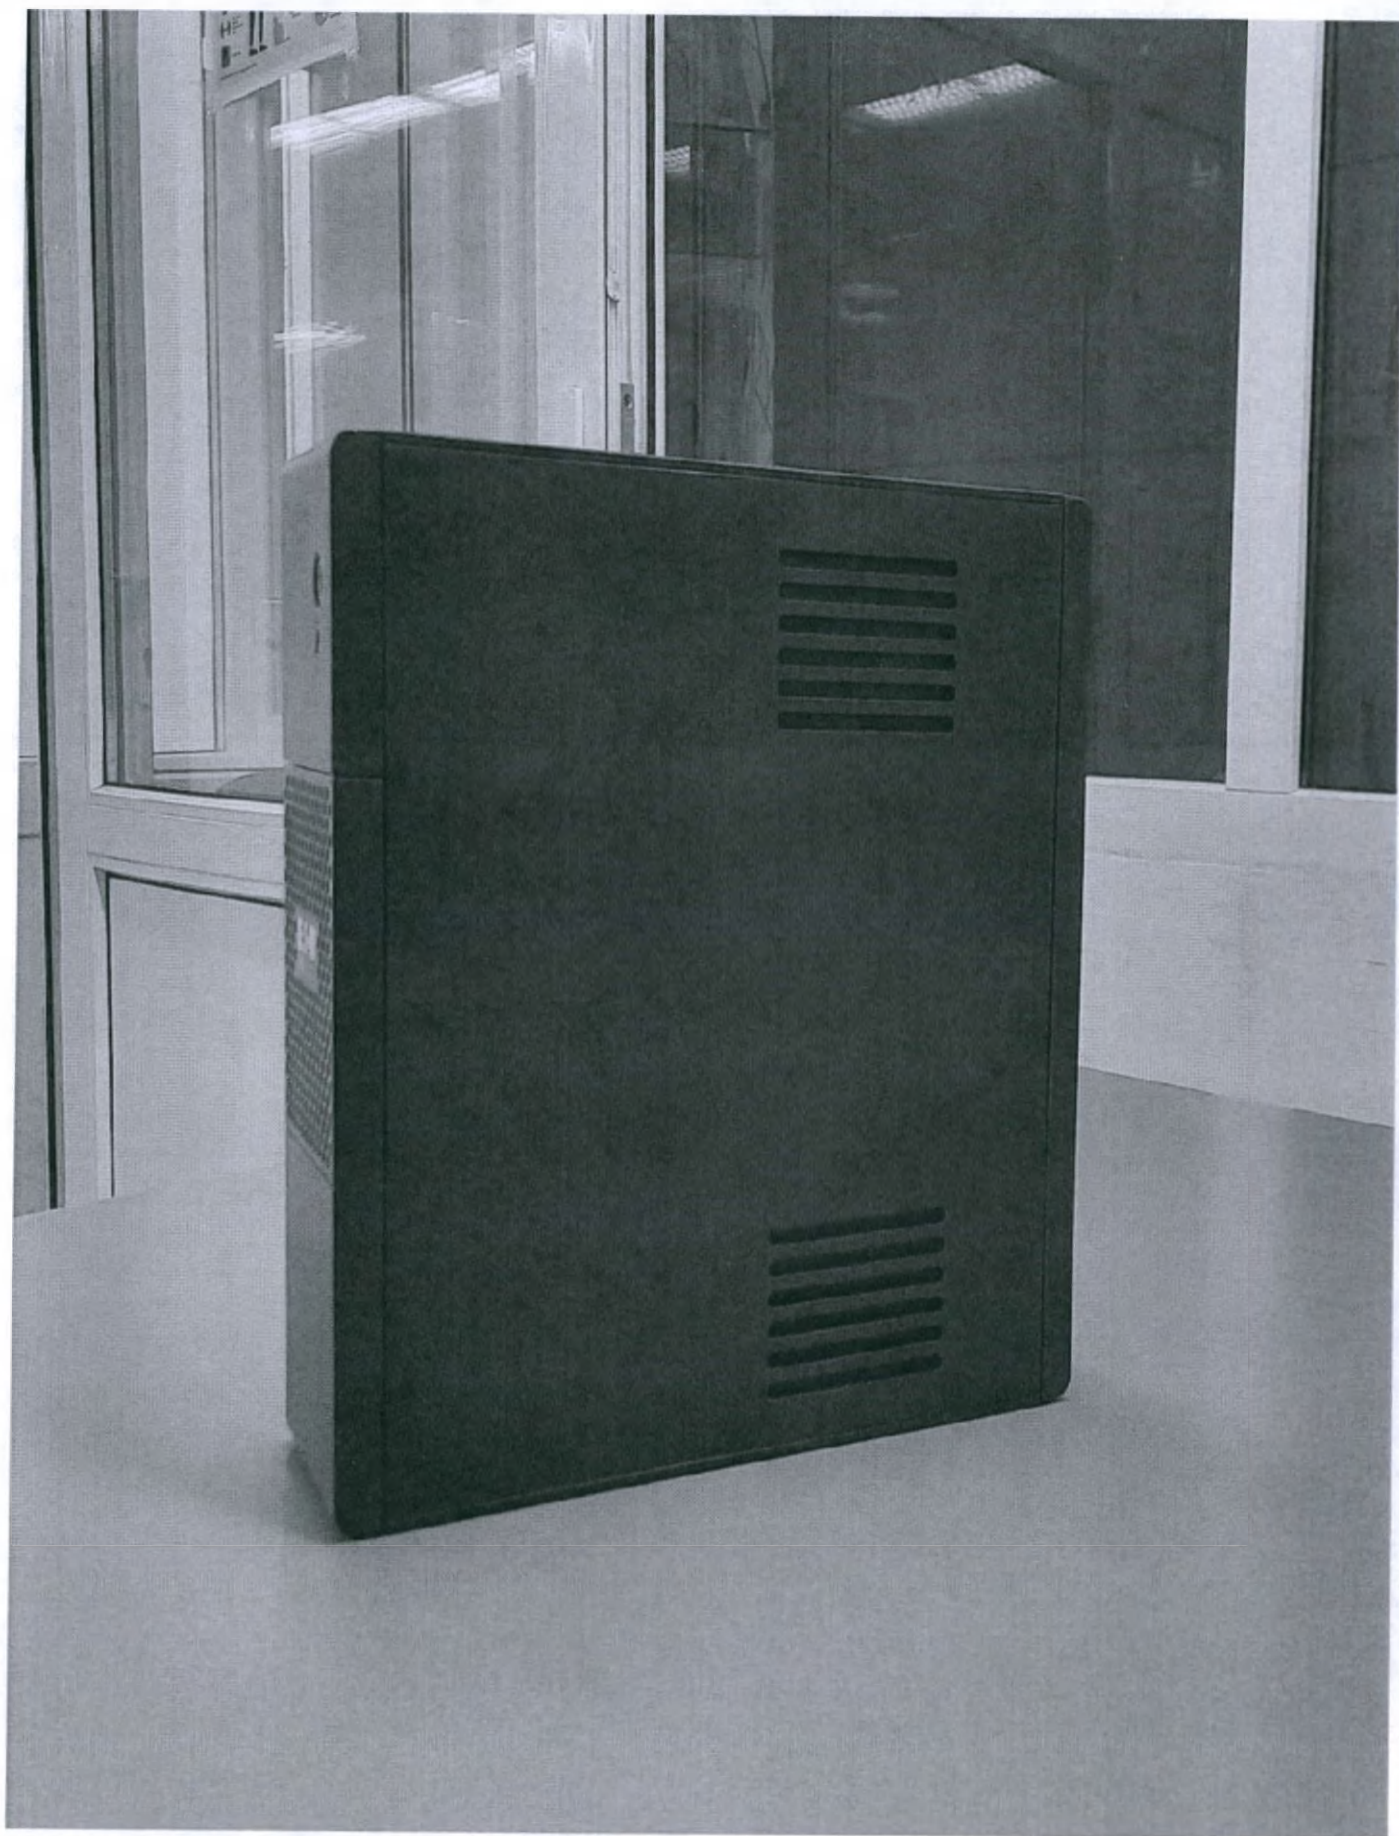


Рис 36. - Источник бесперебойного питания

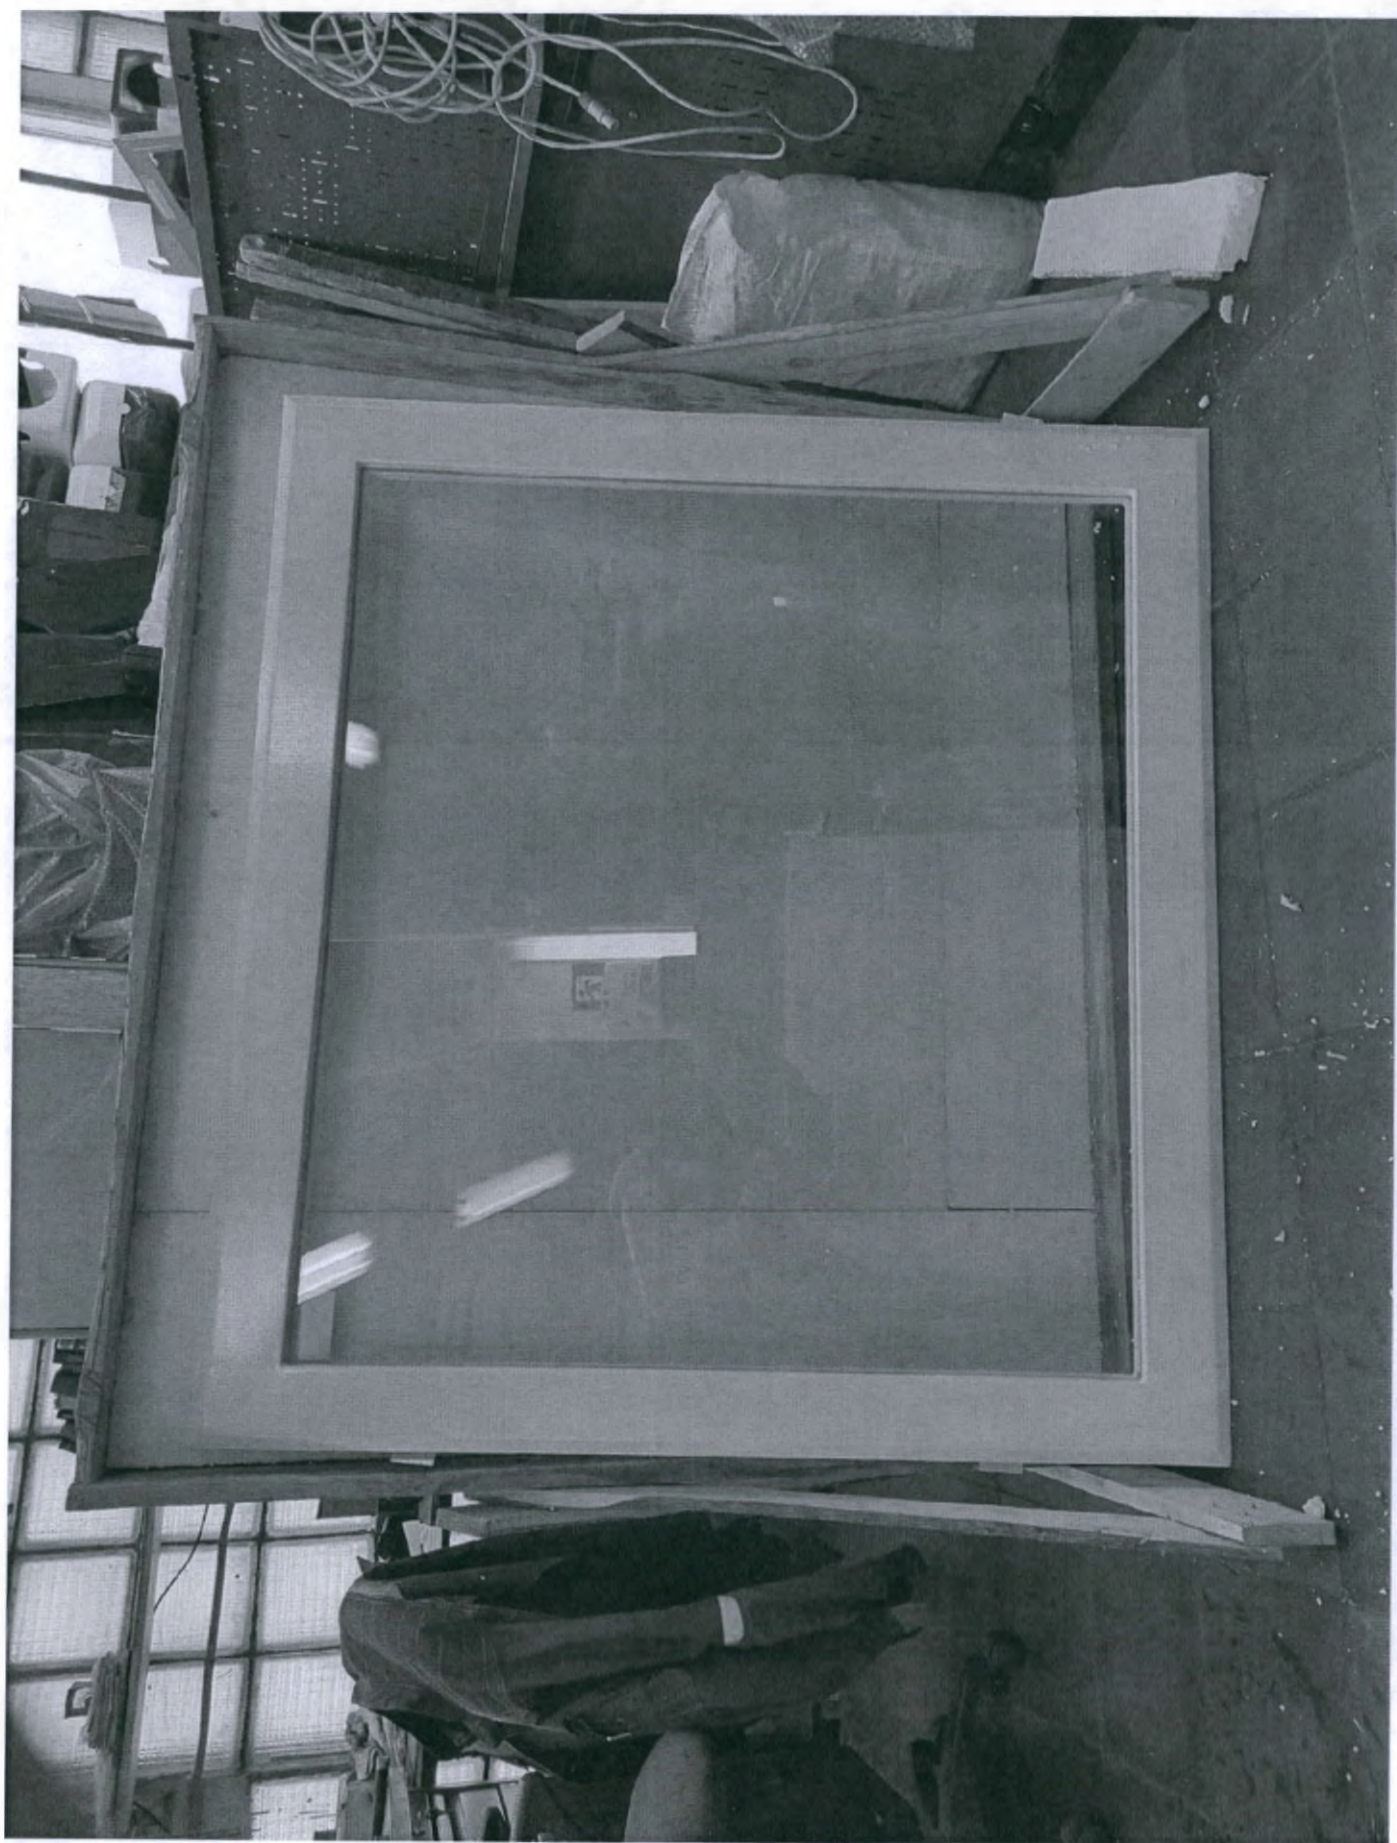


Рис 37. - Оконный блок смотровой рентгенозащитный


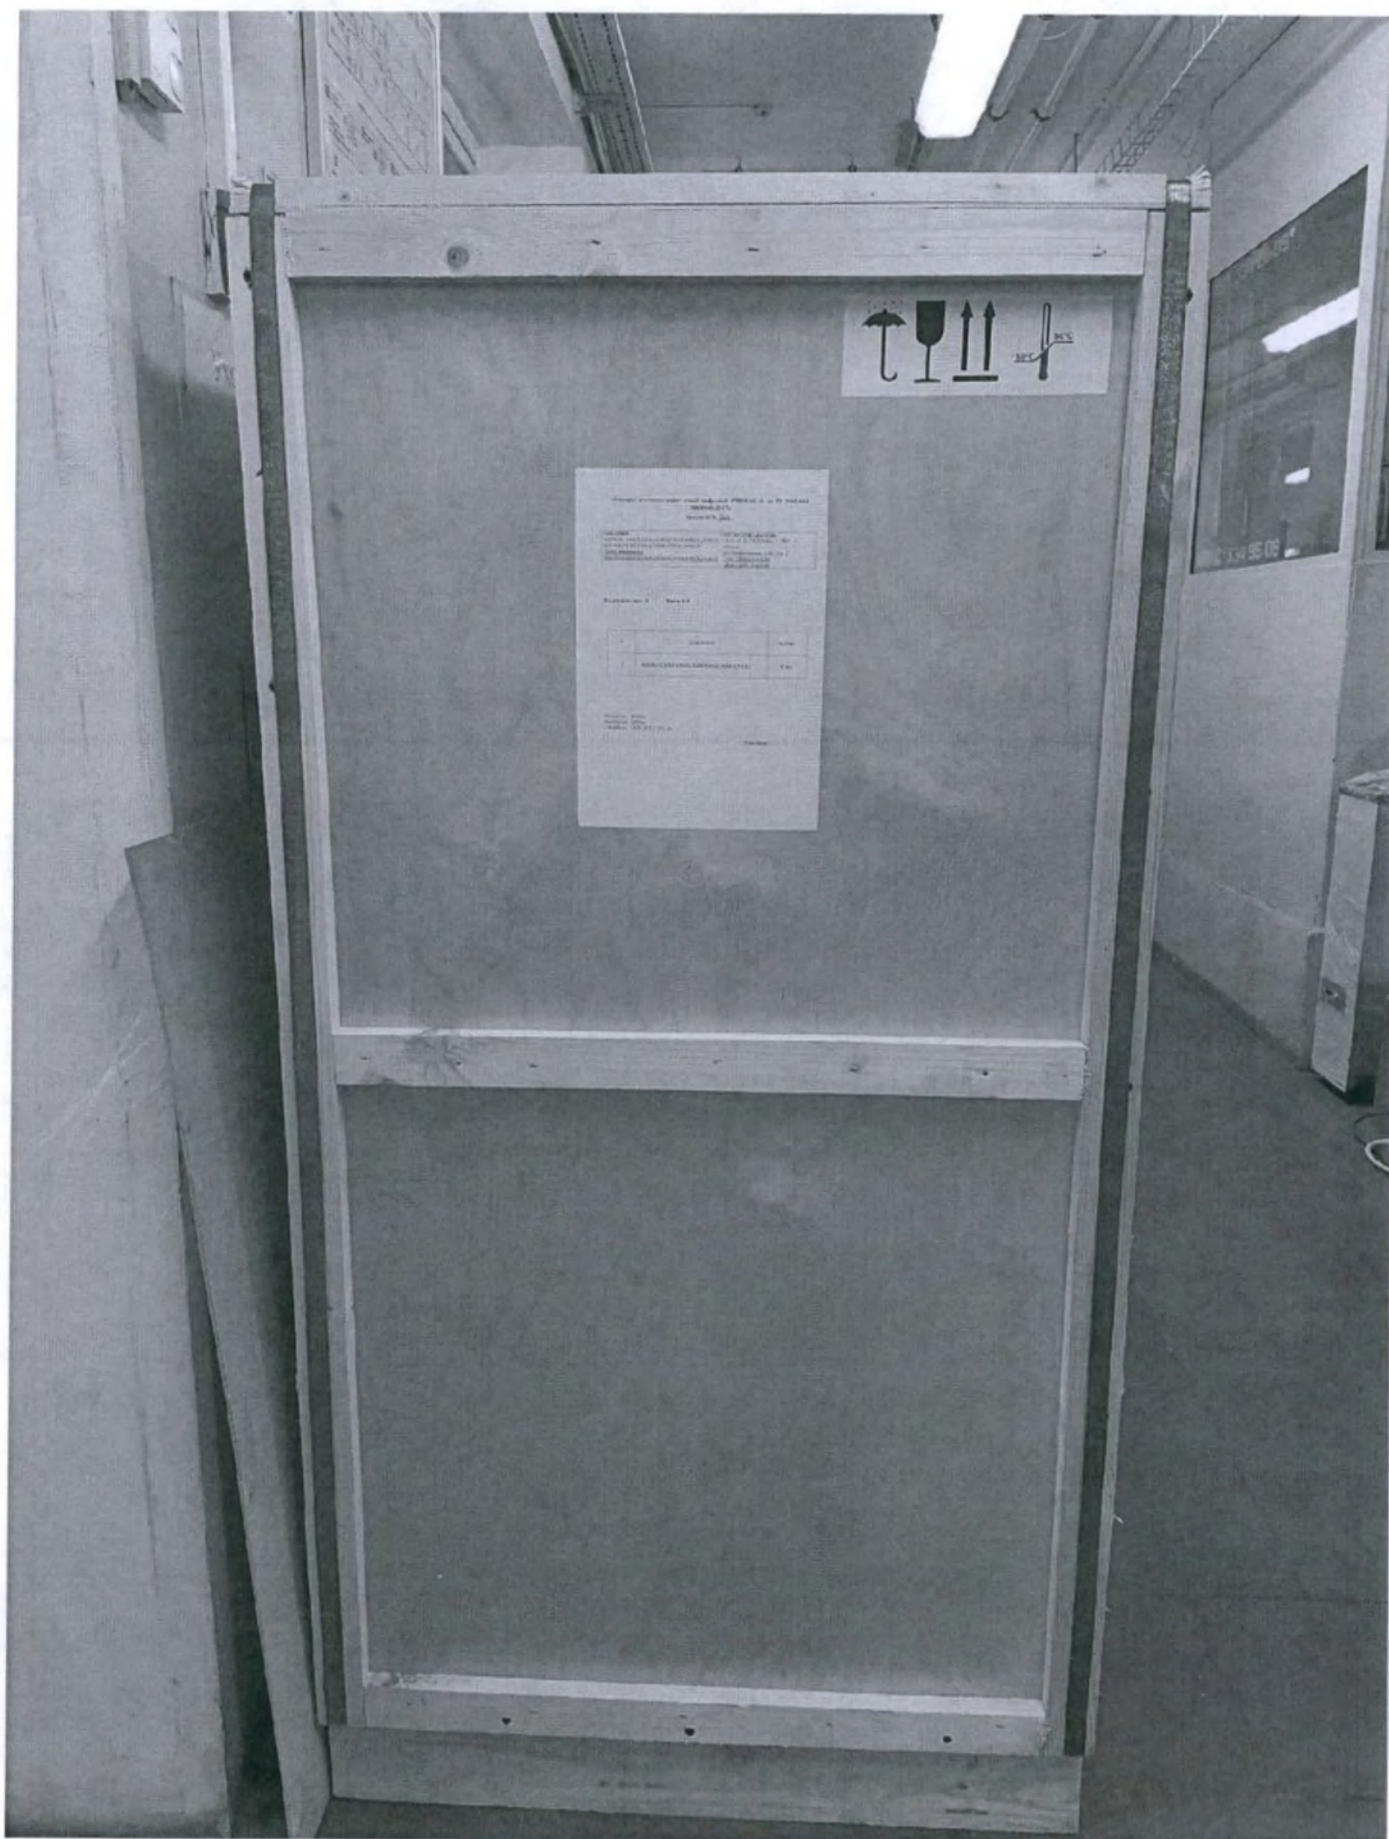


Рис 38. - Фото упаковки

ООО "С.П.ГЕЛПИК"

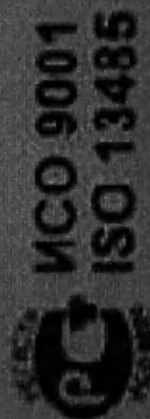

117485, г. Москва
Ул. Профсоюзная, 86 стр. 2
Тел.: (495) 334-82-69
Факс.: (495) 334-95-09

Аппарат флюорографический цифровой «РЕНЕКС-ФЦМ»
по ТУ 26.60.11-057-54839165-2021

1/Н/ЗП 230В 50 Гц ~ 25А



РУ №

Исполнение 1

Заводской №

1740/1

Дата выпуска

12.2021

Рис 39. - Фото маркировки

В данном документе
пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью всего 52 (пятьдесят два) листов
Генеральный директор
ООО "С.П.ГЕЛПИК"
Аврамов В.В.

