

Фотографические изображения медицинского изделия

Томограф компьютерный Revolution CT, Revolution CT ES с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Лидер по регистрации

ООО «ДжиИ Хэлскеа»


Ю.Н.Дорофеева
« 31 » сентября 2022 г

Производства

GE Medical Systems, LLC

3000 N. Grandview Blvd., Waukesha, WI 53188, USA



GE MEDICAL SYSTEMS, LLC

3000 N. GRANDVIEW BLVD., WAUKESHA, WI., U.S.A.

Модель: Revolution CT

Номинальное напряжение: 380/400/420/440/460/480В, 3~

Кратковременная мощность: 150 кВА

Длительная мощность: 30 кВА

Частота: 50/60 Гц



Класс 1
IPX0



СДЕЛАНО ДЛЯ
GE MEDICAL SYSTEMS, LLC
3000 N. GRANDVIEW BLVD., WAUKESHA, WI., U.S.A.

СДЕЛАНО
GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.
West Area of Building No.3, No.1 Yongchang North Road,
Beijing Economic and Technological Development Area,
BEIJING 100176 CHINA

Модель: Revolution CT

Номинальное напряжение: 380/400/420/440/460/480В, 3~

Кратковременная мощность: 150 кВА

Длительная мощность: 30 кВА

Частота: 50/60 Гц



Класс 1
IPX0



GE MEDICAL SYSTEMS, LLC

3000 N. GRANDVIEW BLVD., WAUKESHA, WI., U.S.A.

Модель: Revolution CT ES

Номинальное напряжение: 380/400/420/440/460/480В, 3~

Кратковременная мощность: 150 кВА

Длительная мощность: 30 кВА

Частота: 50/60 Гц



Класс 1
IPX0



СДЕЛАНО ДЛЯ

GE MEDICAL SYSTEMS, LLC

3000 N. GRANDVIEW BLVD., WAUKESHA, WI., U.S.A.

СДЕЛАНО

GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.

West Area of Building No.3, No.1 Yongchang North Road,
Beijing Economic and Technological Development Area,
BEIJING 100176 CHINA

Модель: Revolution CT ES

Номинальное напряжение: 380/400/420/440/460/480В, 3~

Кратковременная мощность: 150 кВА

Длительная мощность: 30 кВА

Частота: 50/60 Гц




Класс 1
IPX0


I. Томограф компьютерный Revolution CT, Revolution CT ES



1. Гантри для сканирования.

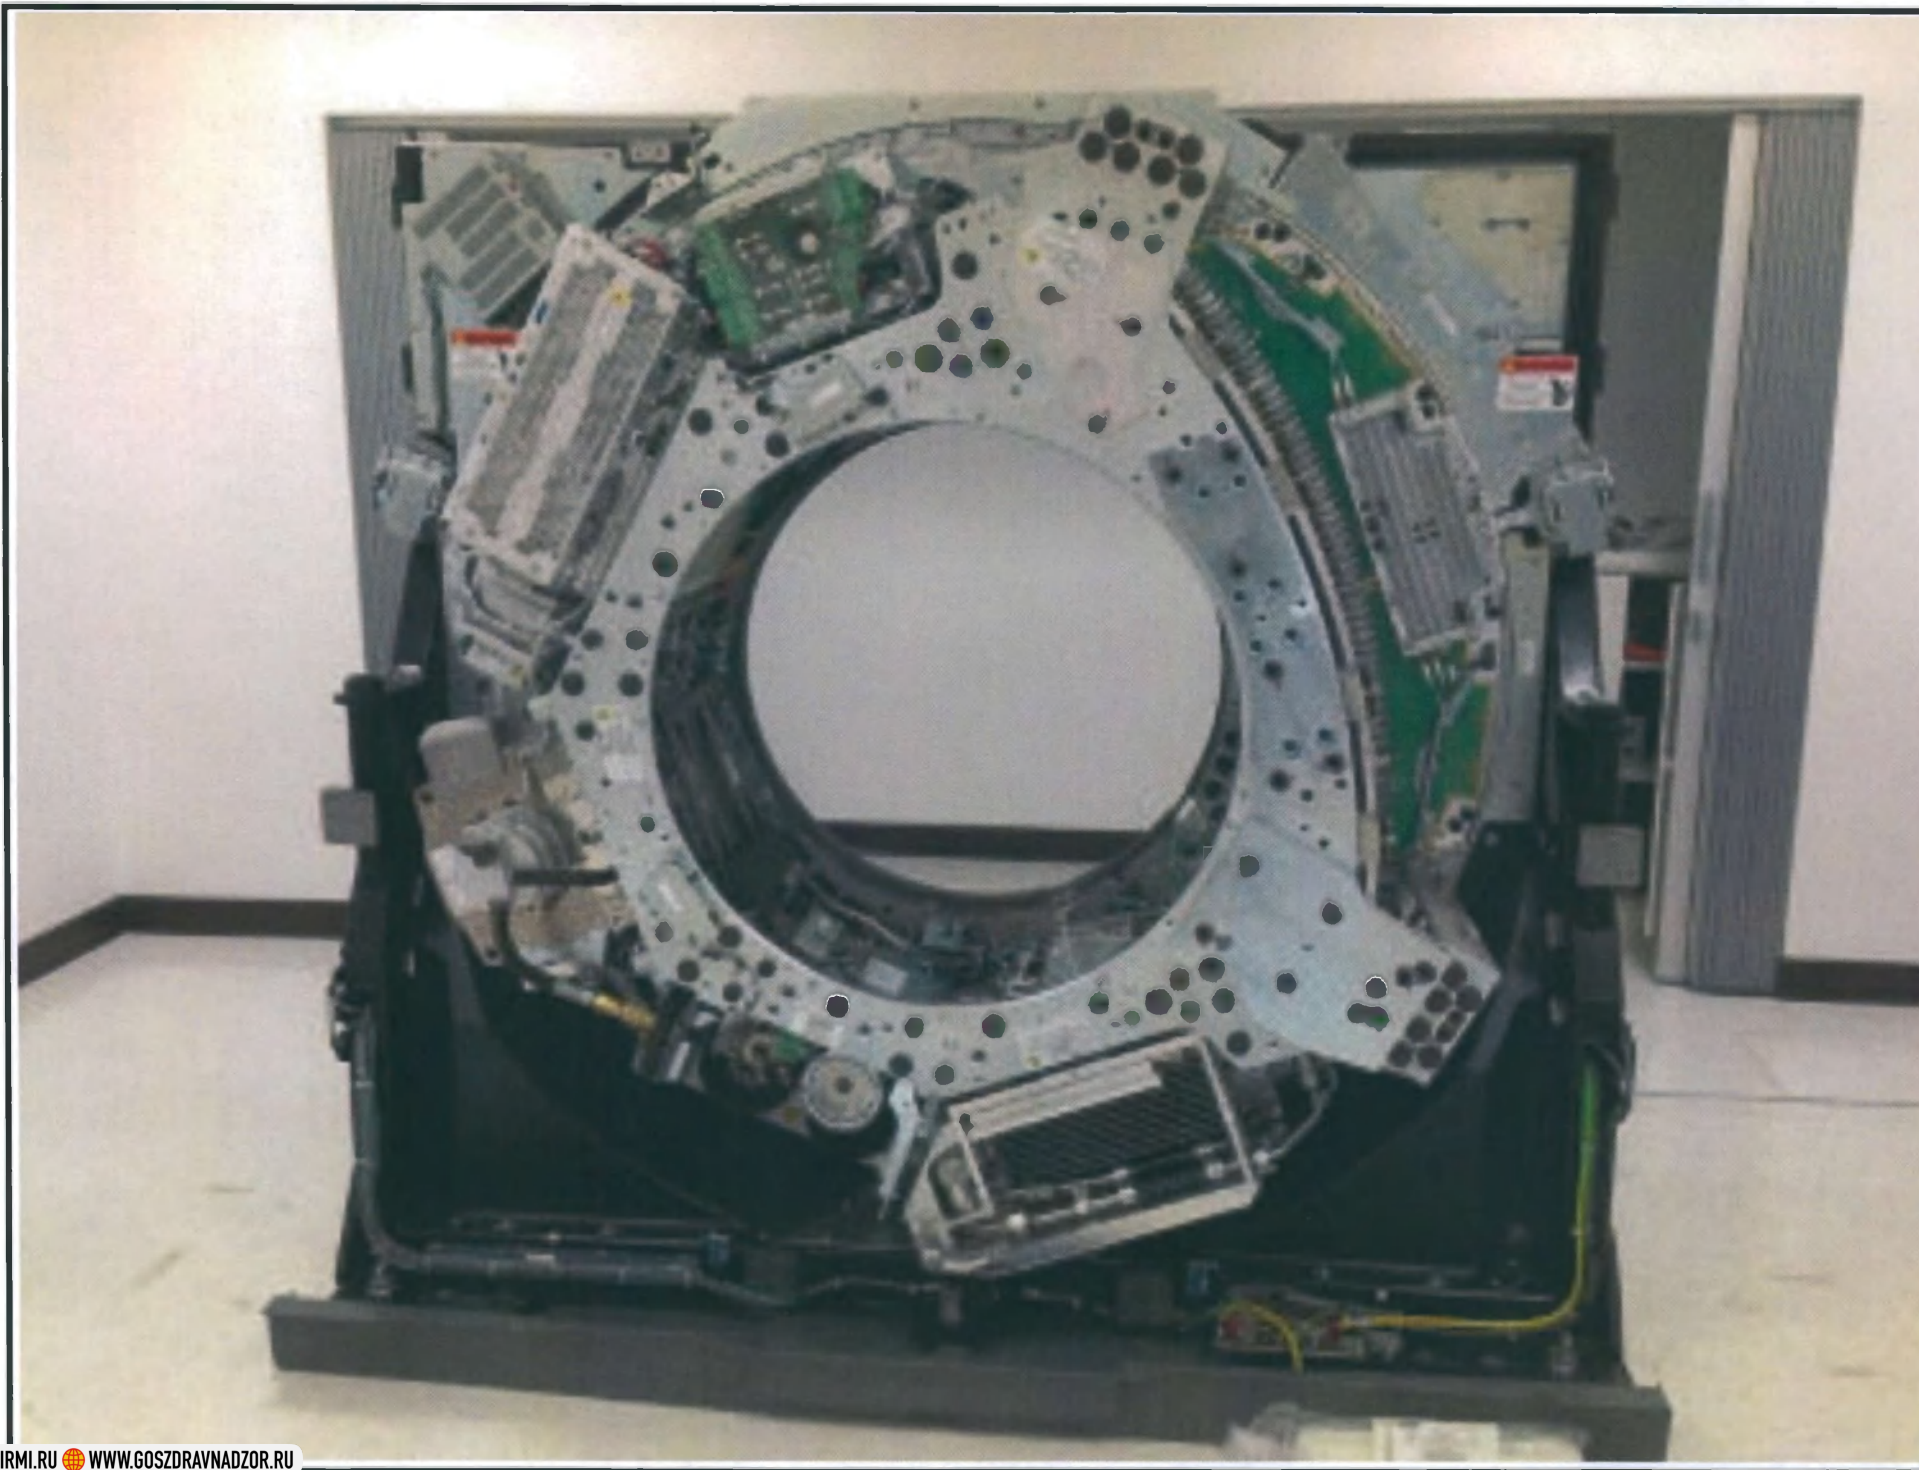

1. Гантри для сканирования.

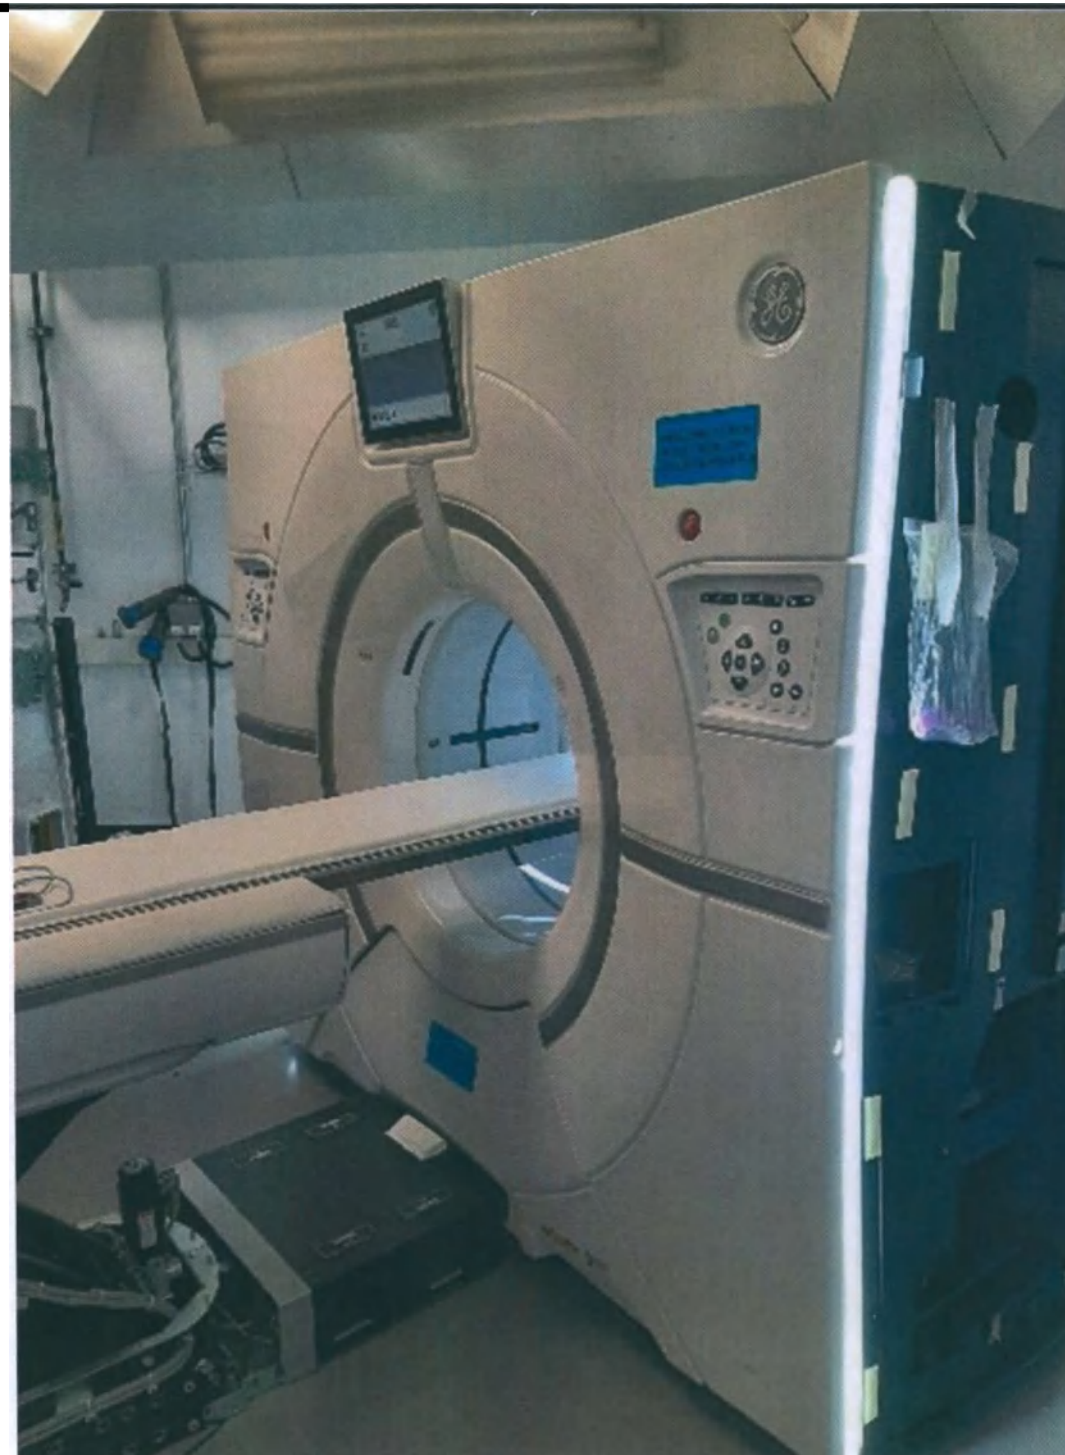


2. Стол для укладки пациента.




2. Стол для укладки пациента.




2. Стол для укладки пациента.

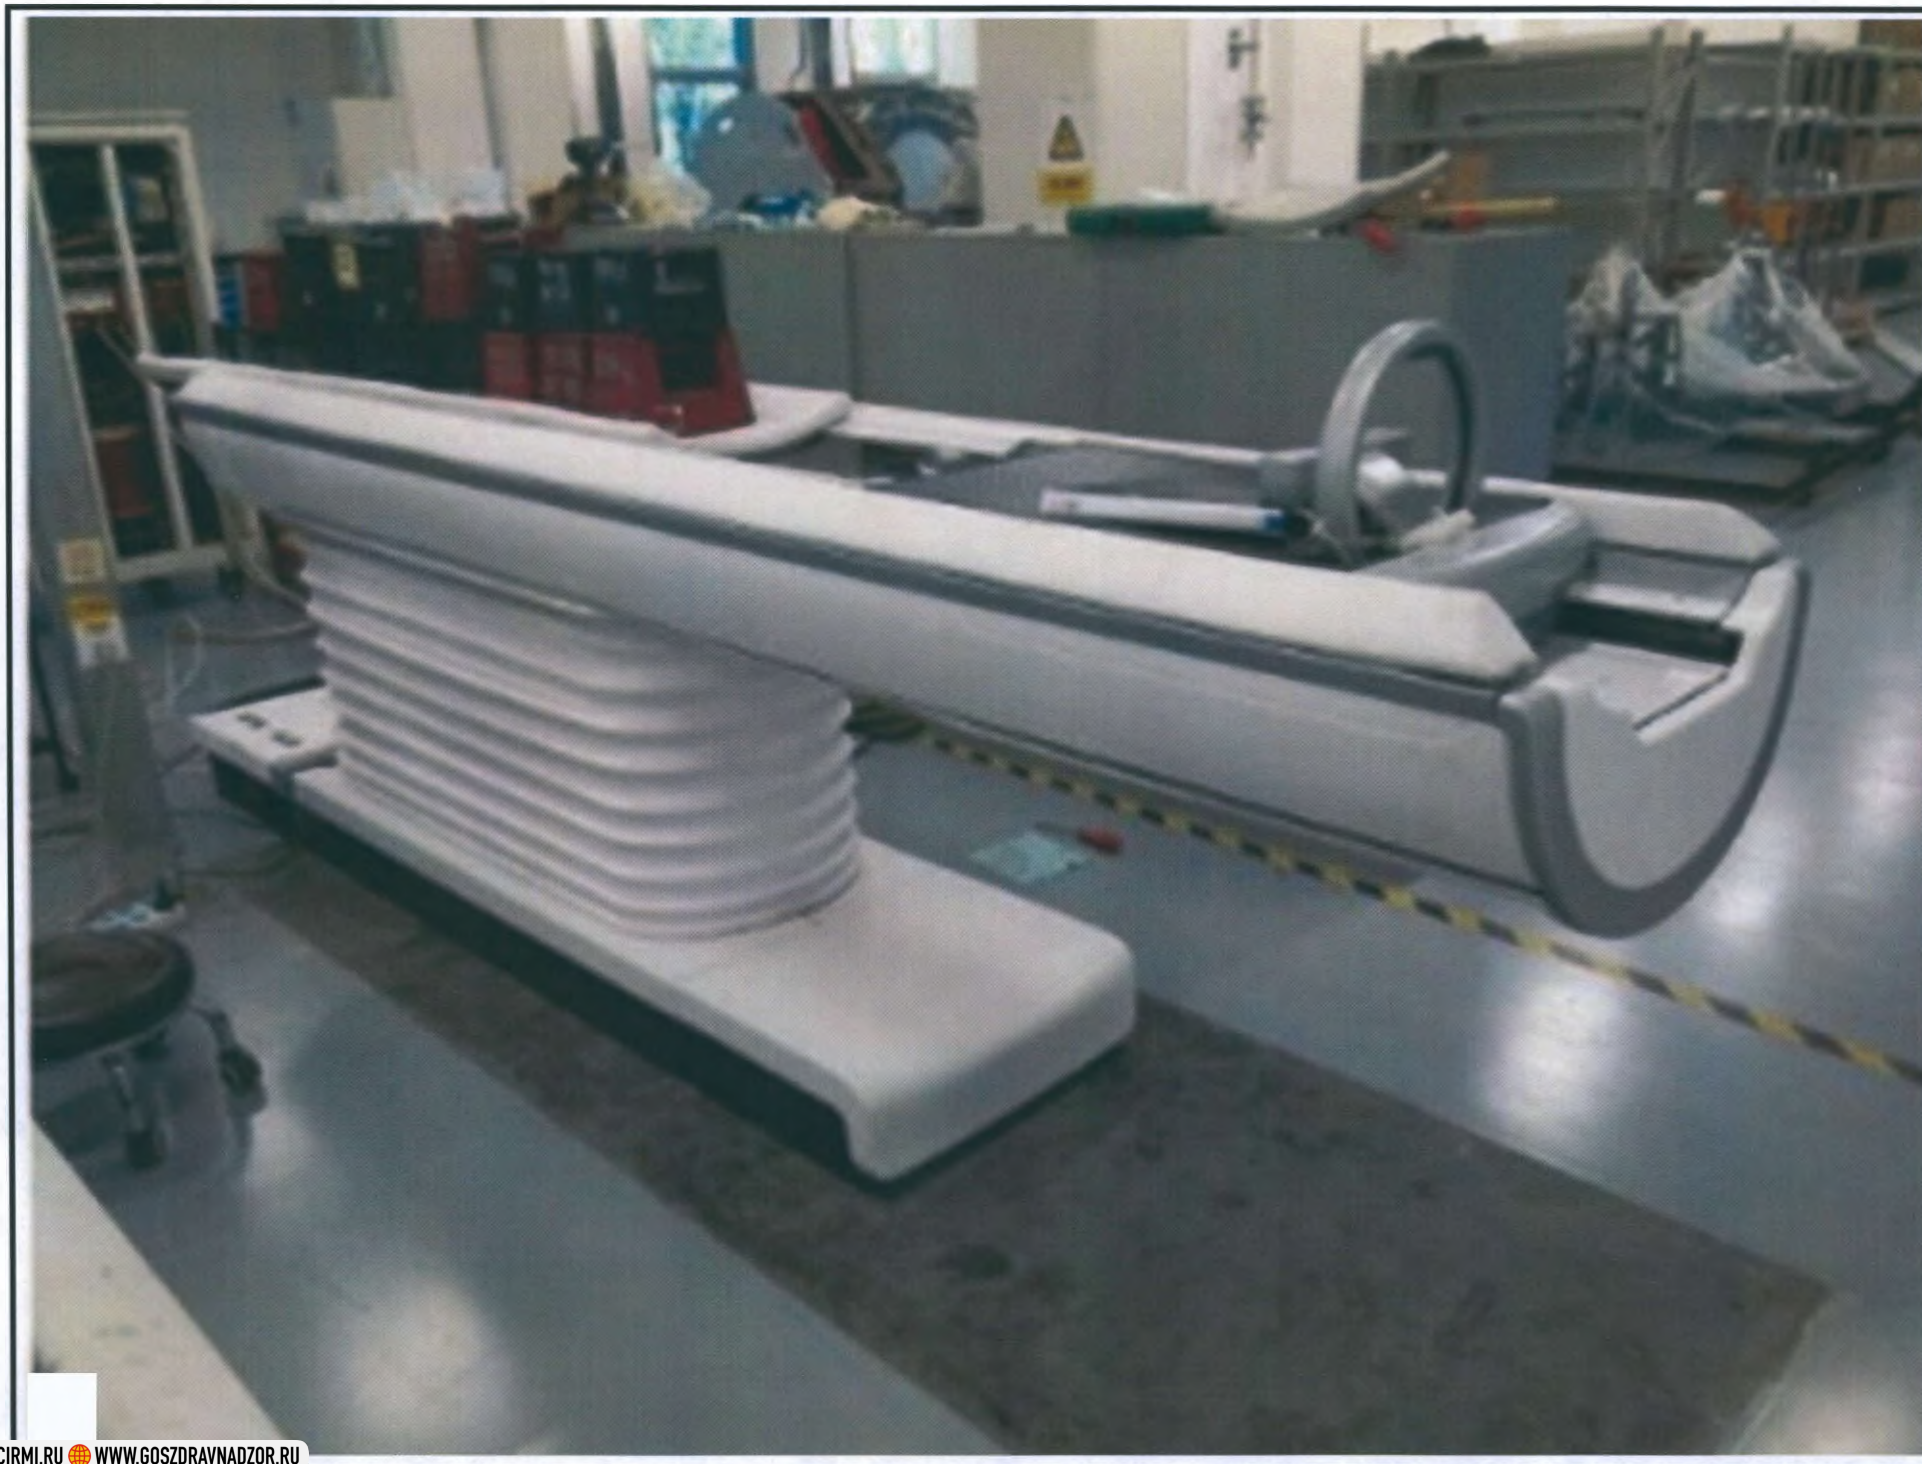


3. Генератор рентгеновский высоковольтный.

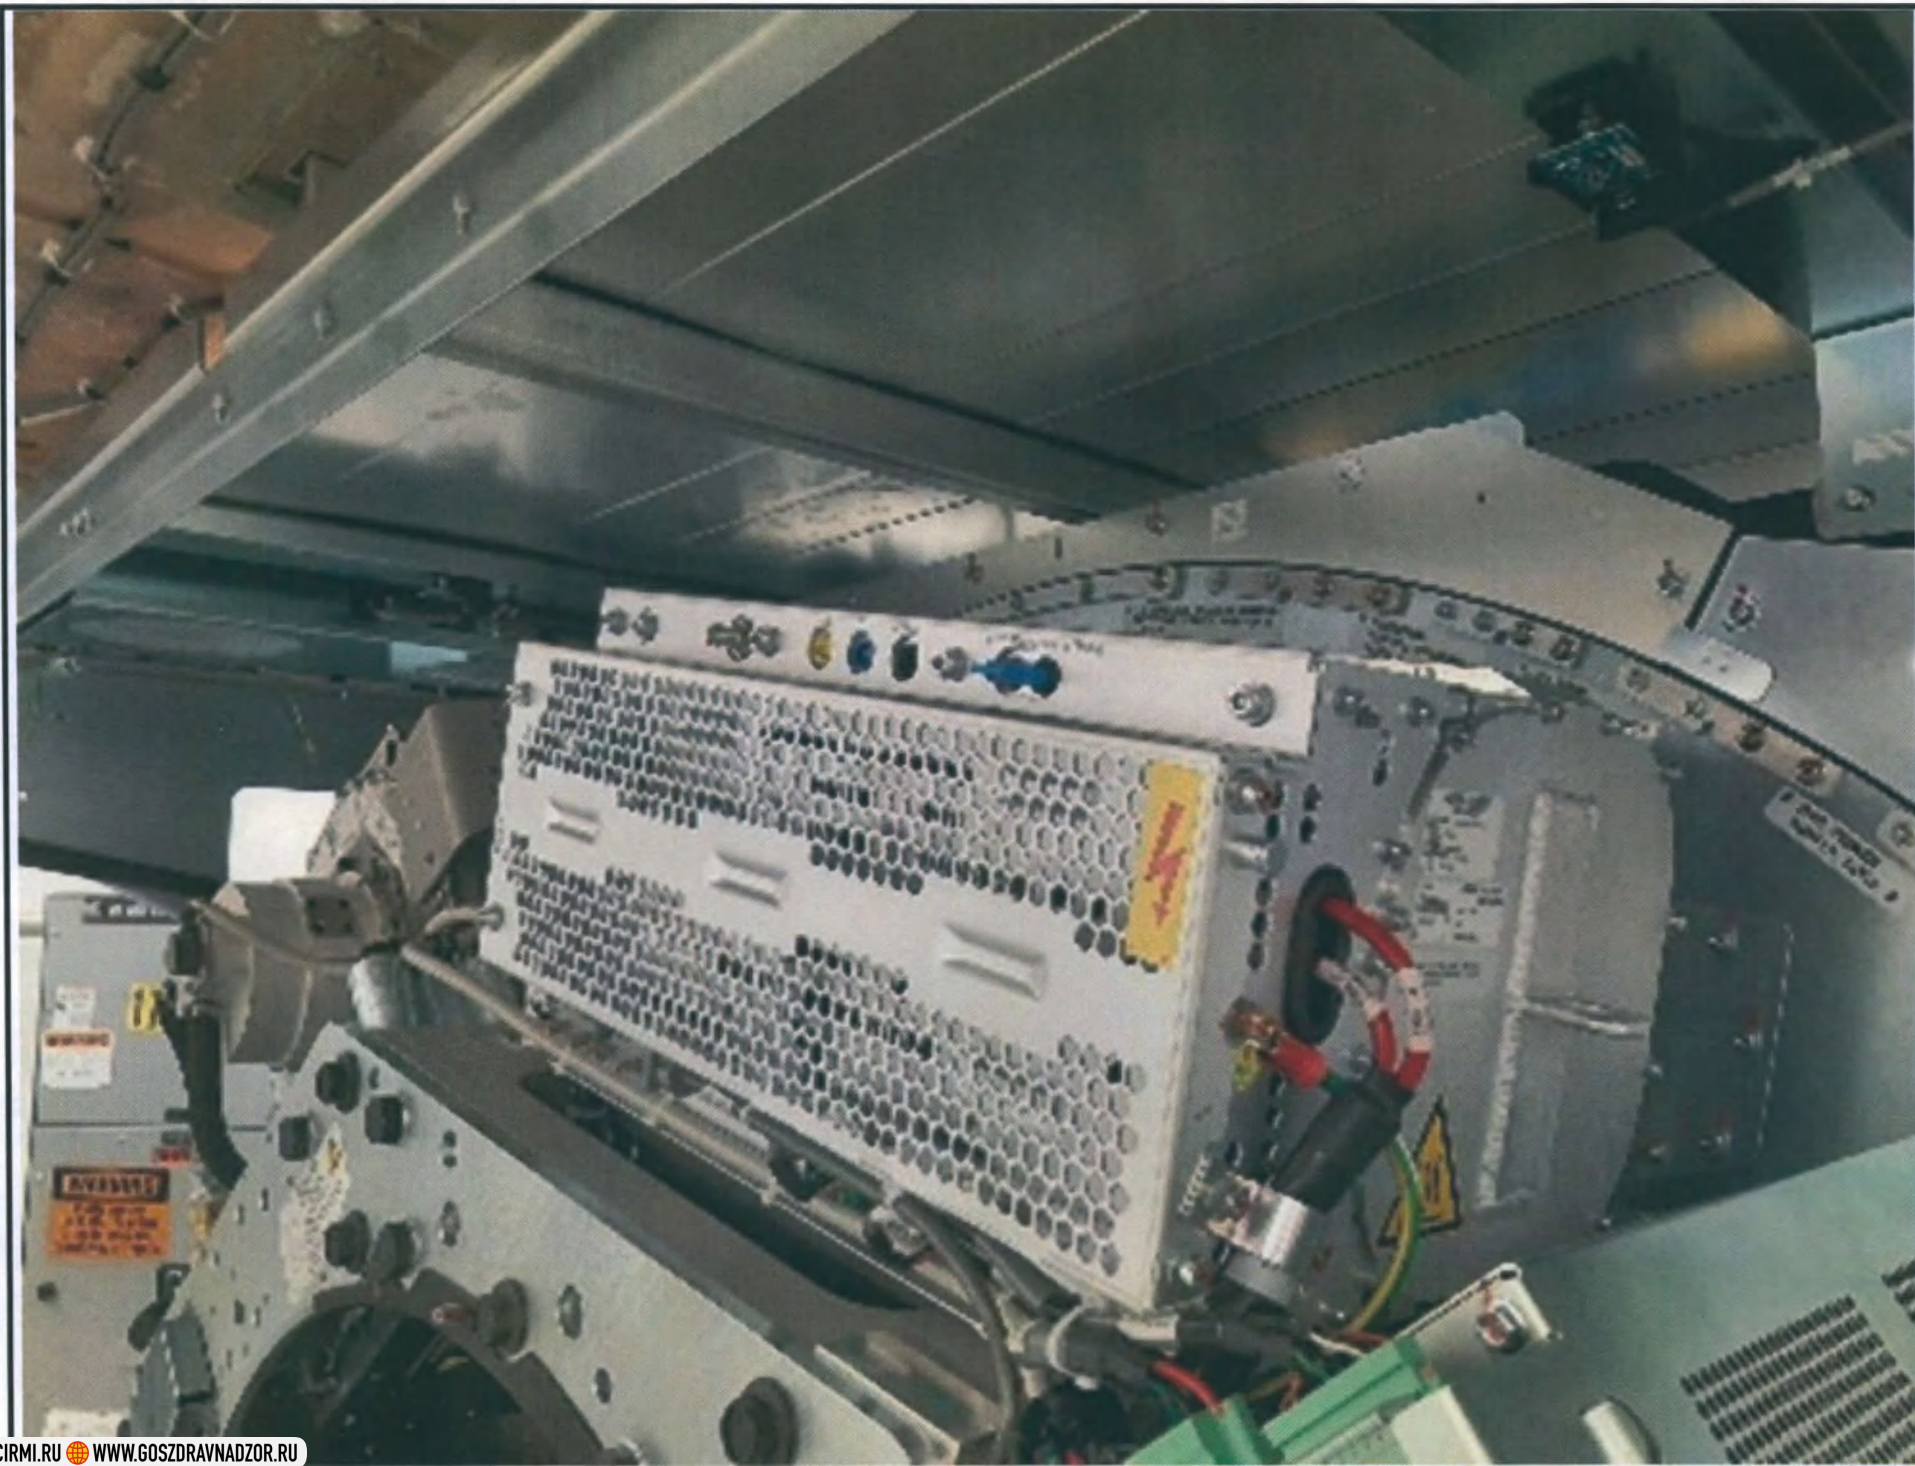



4. Детектор рентгеновского излучения.

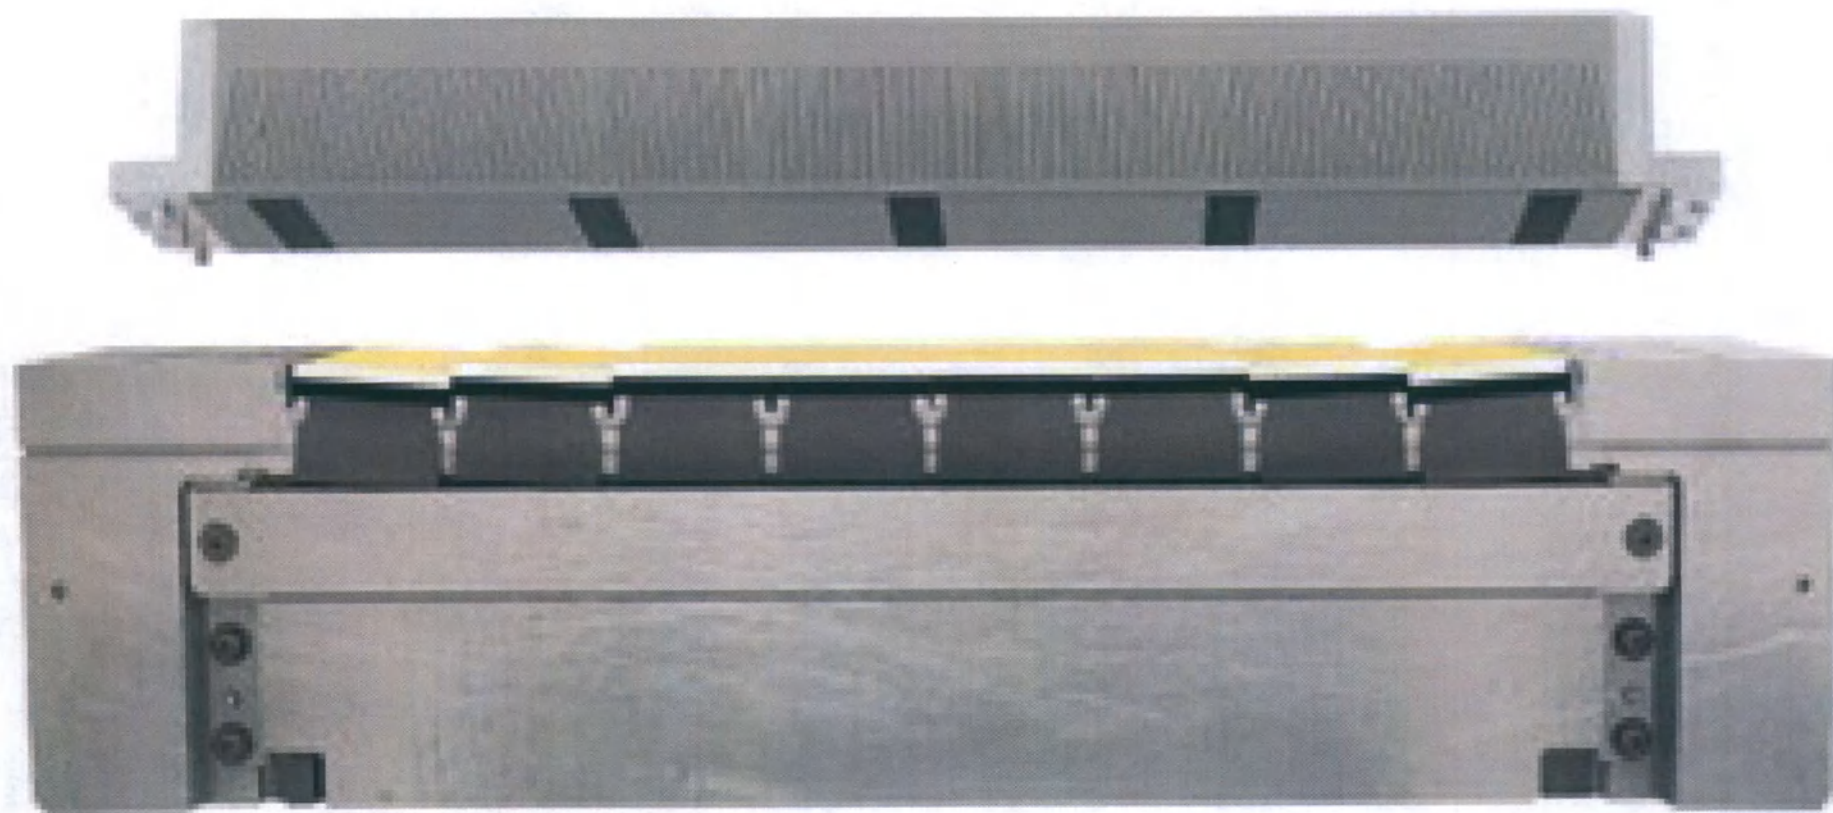

5. Трубка рентгеновская.

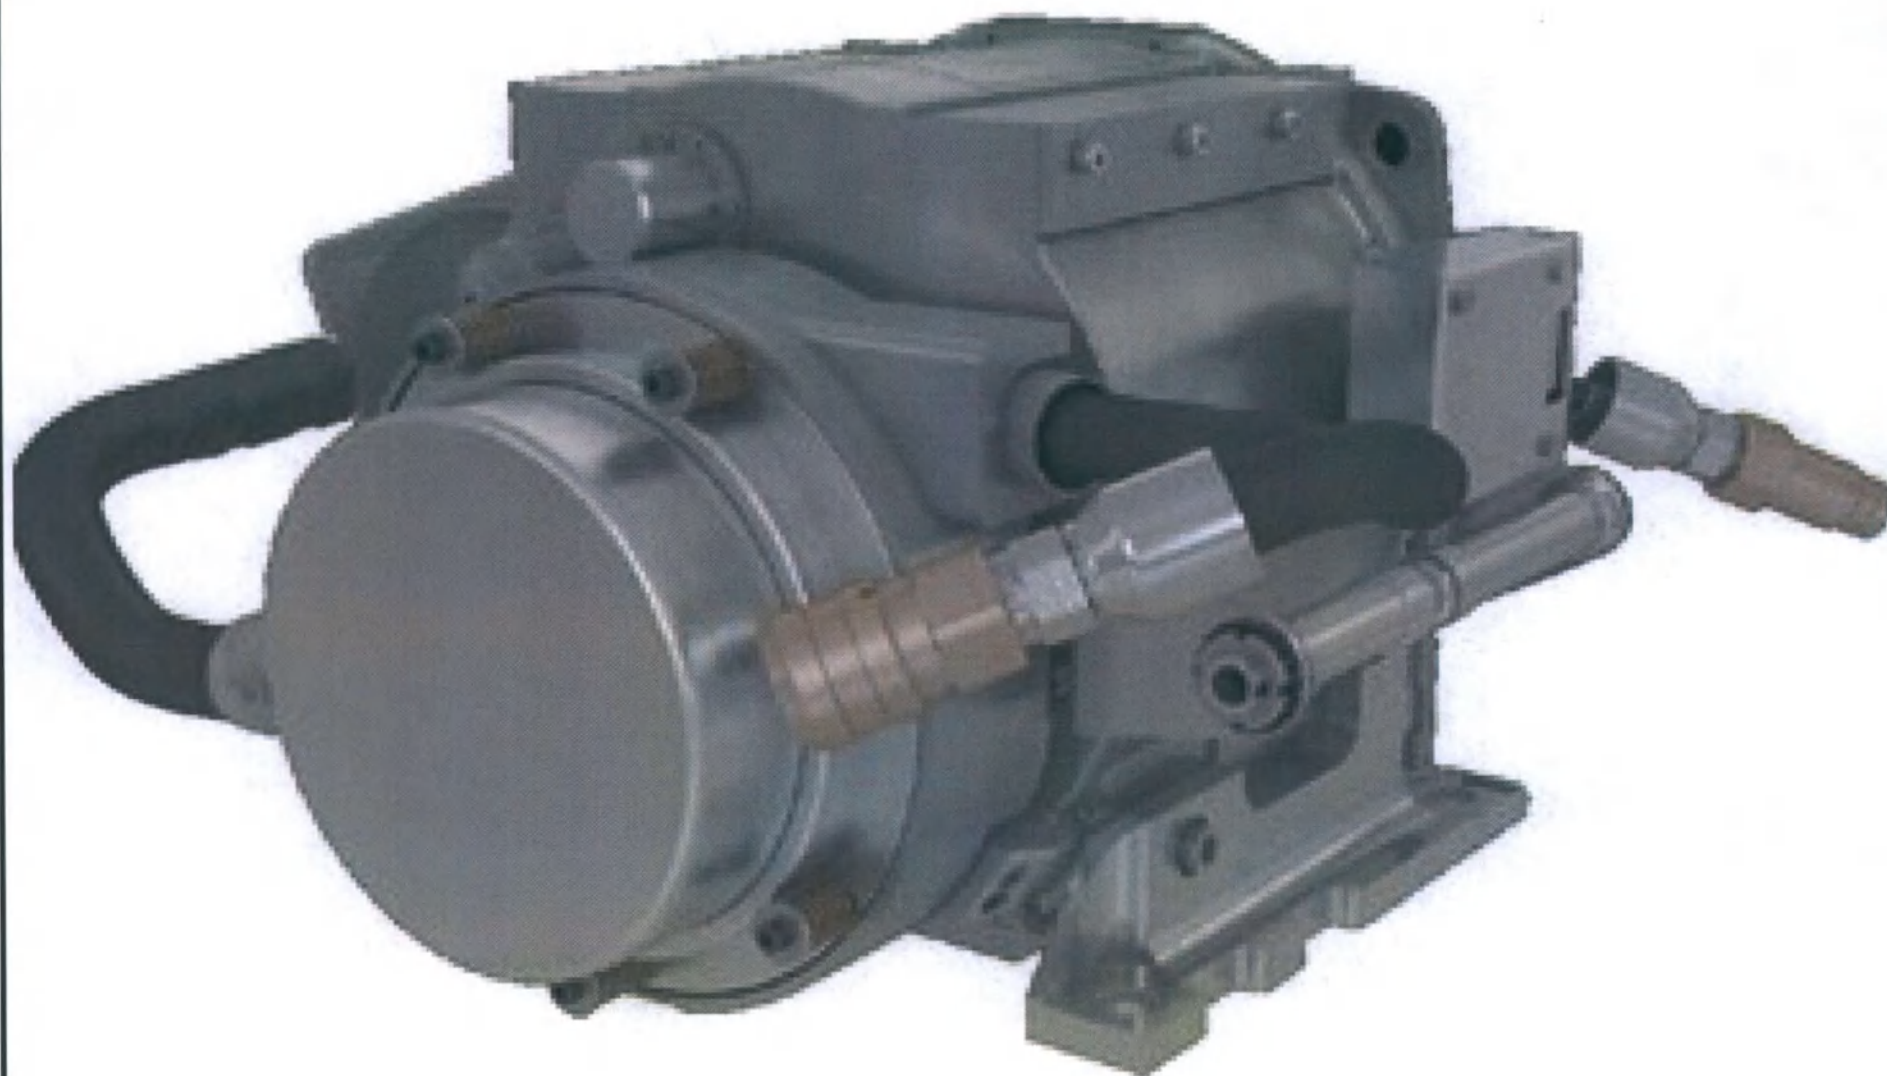

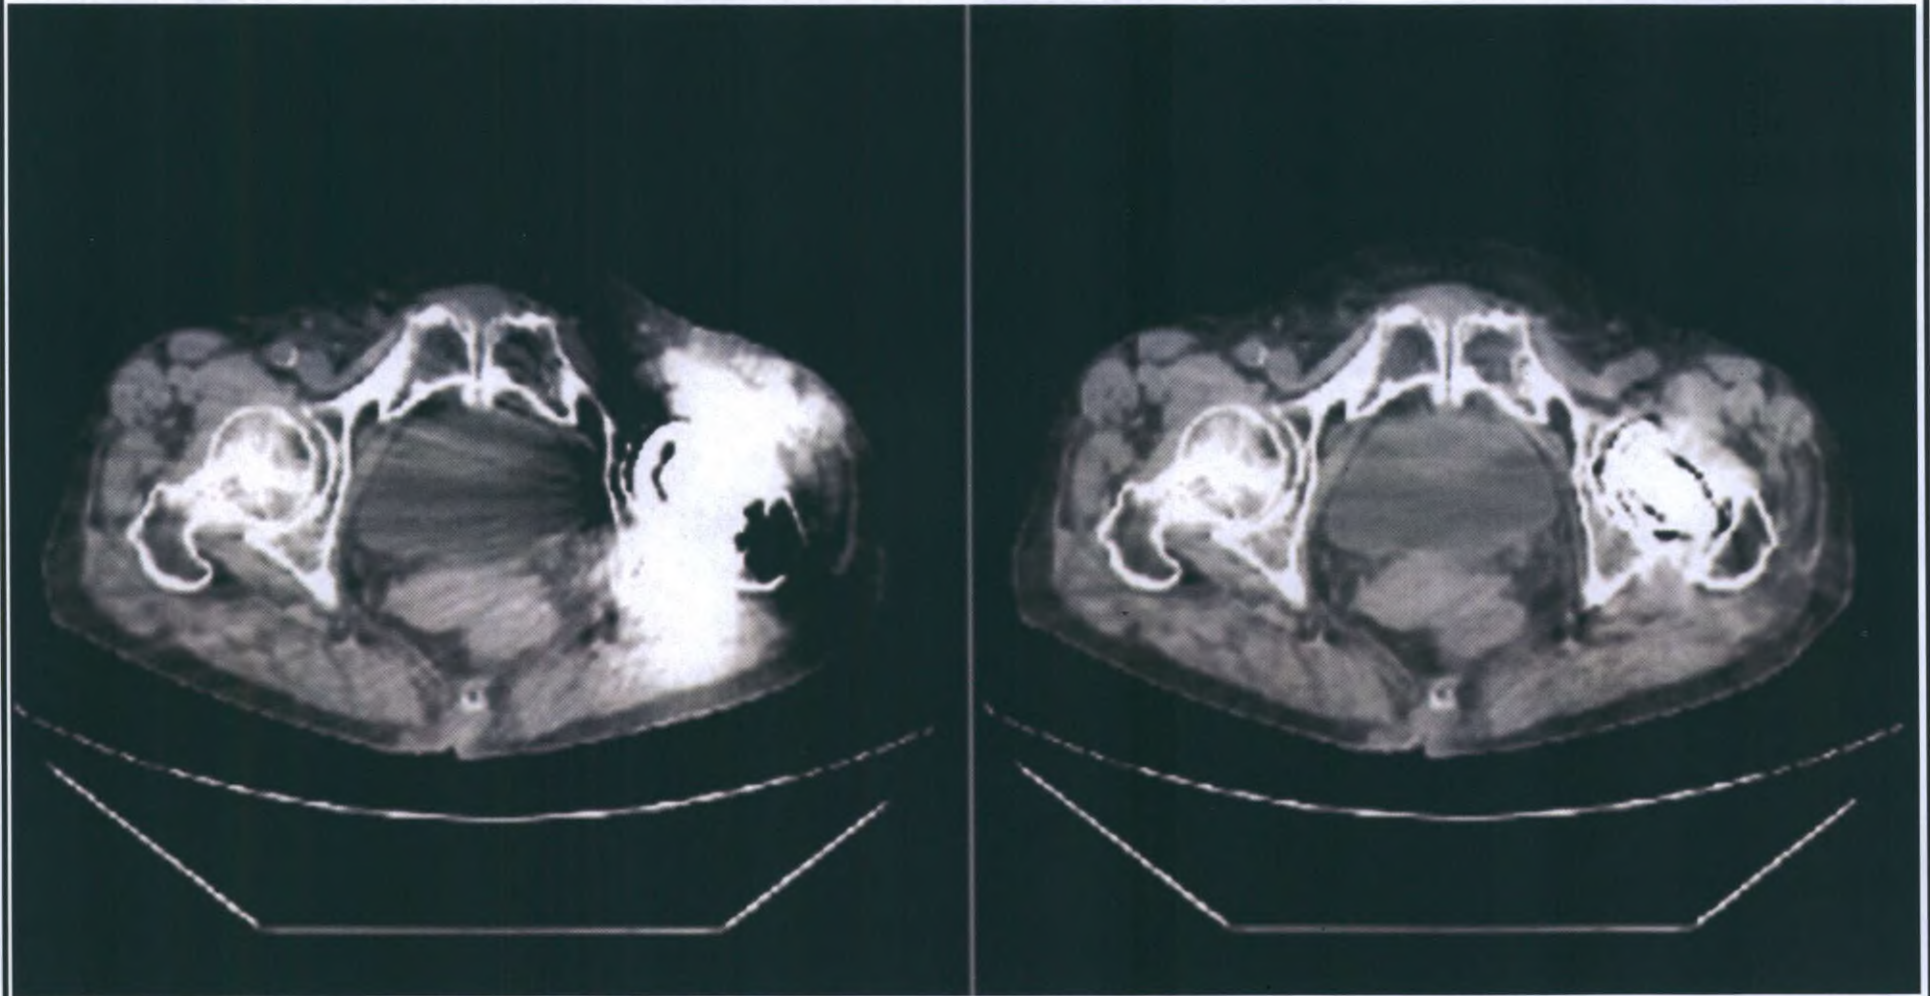

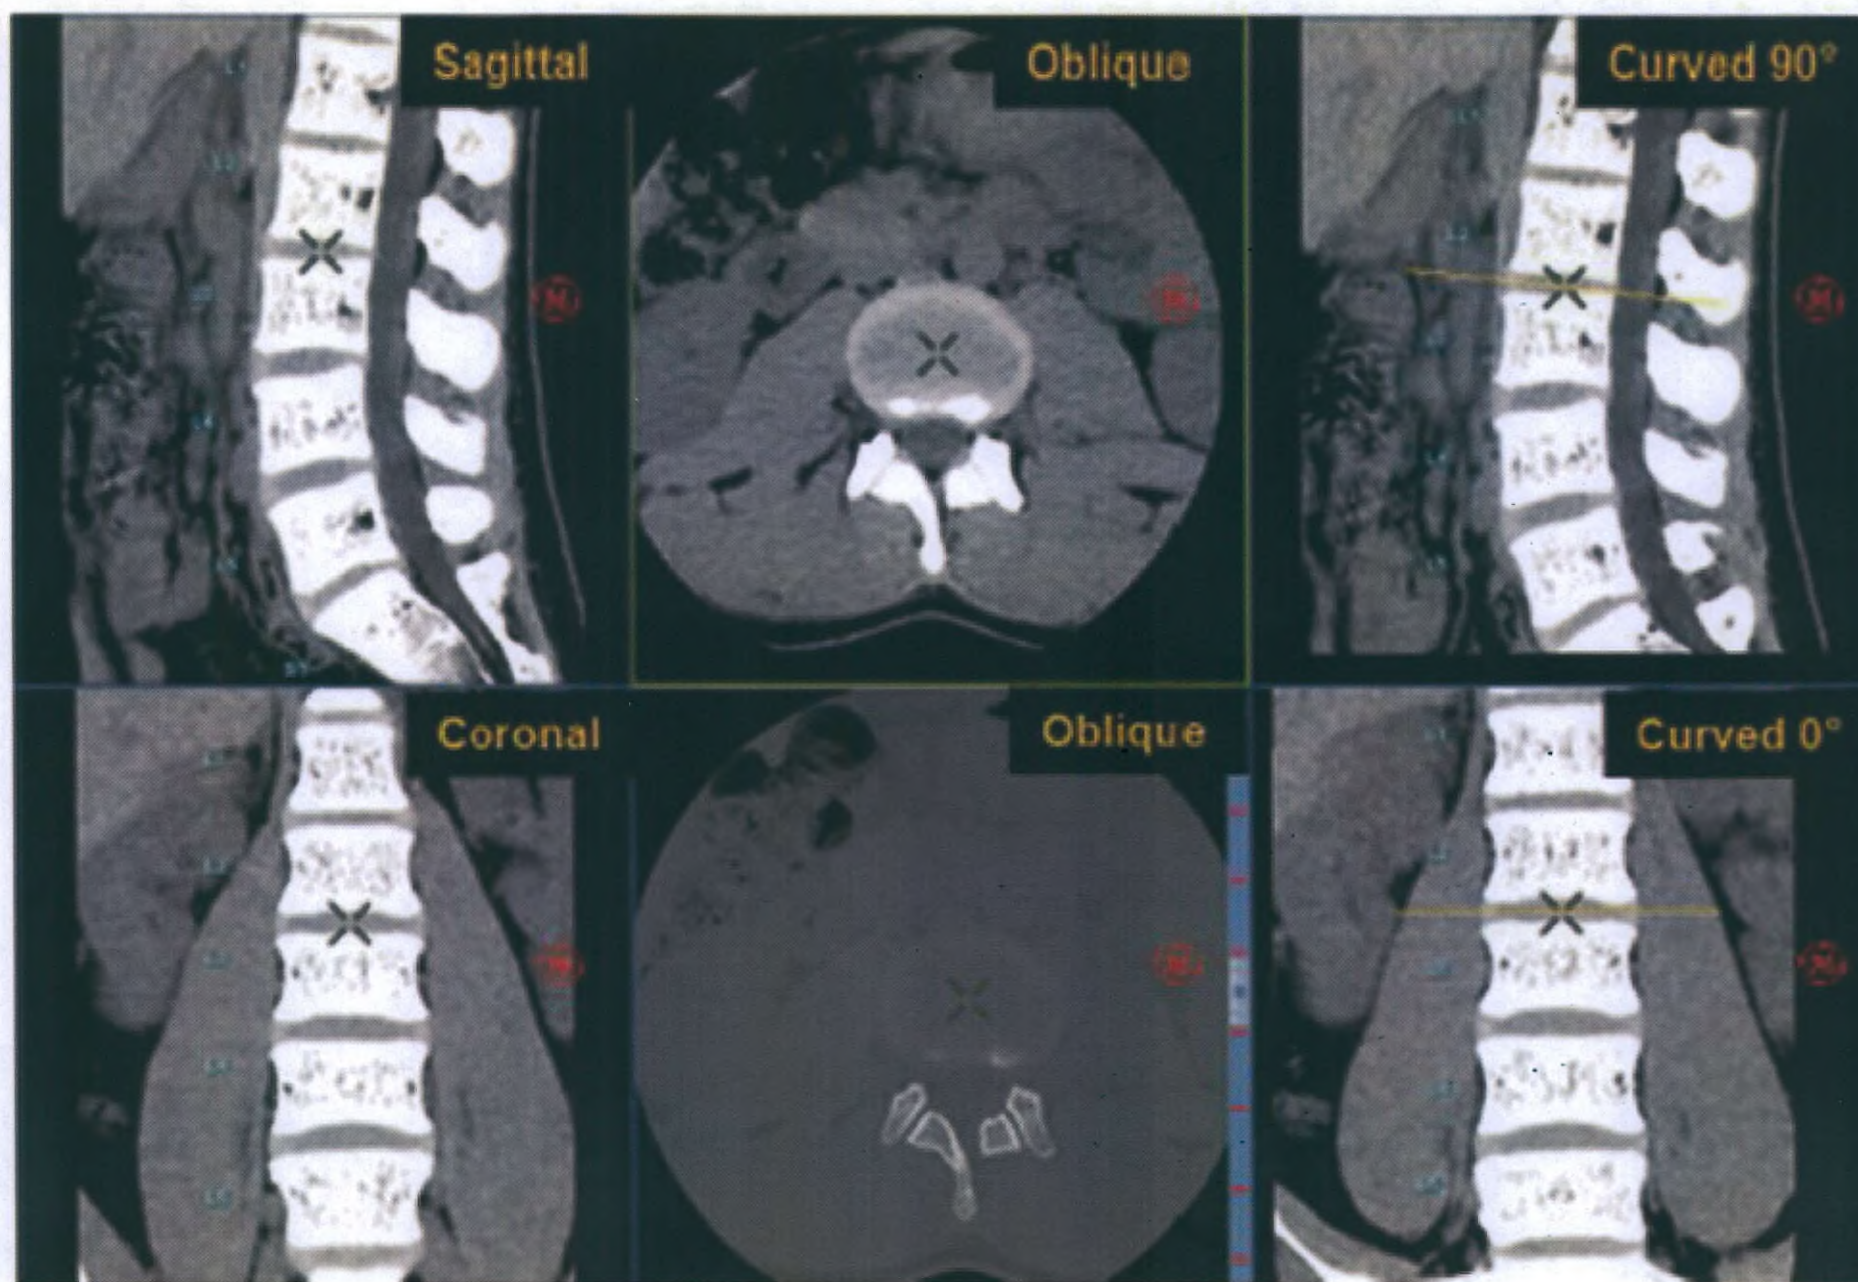

■ Recon Settings

Thickness 5.0 mm

Recon Type Stnd#

Enhanced Contrast EC1

Fine Z (#Z) Off

Recon Mode Plus Off

Image Enhance Filter None

ASiR-V 50%


DLIR High


Window Width Off

Window Level Low


Flip / Rotate Medium

High

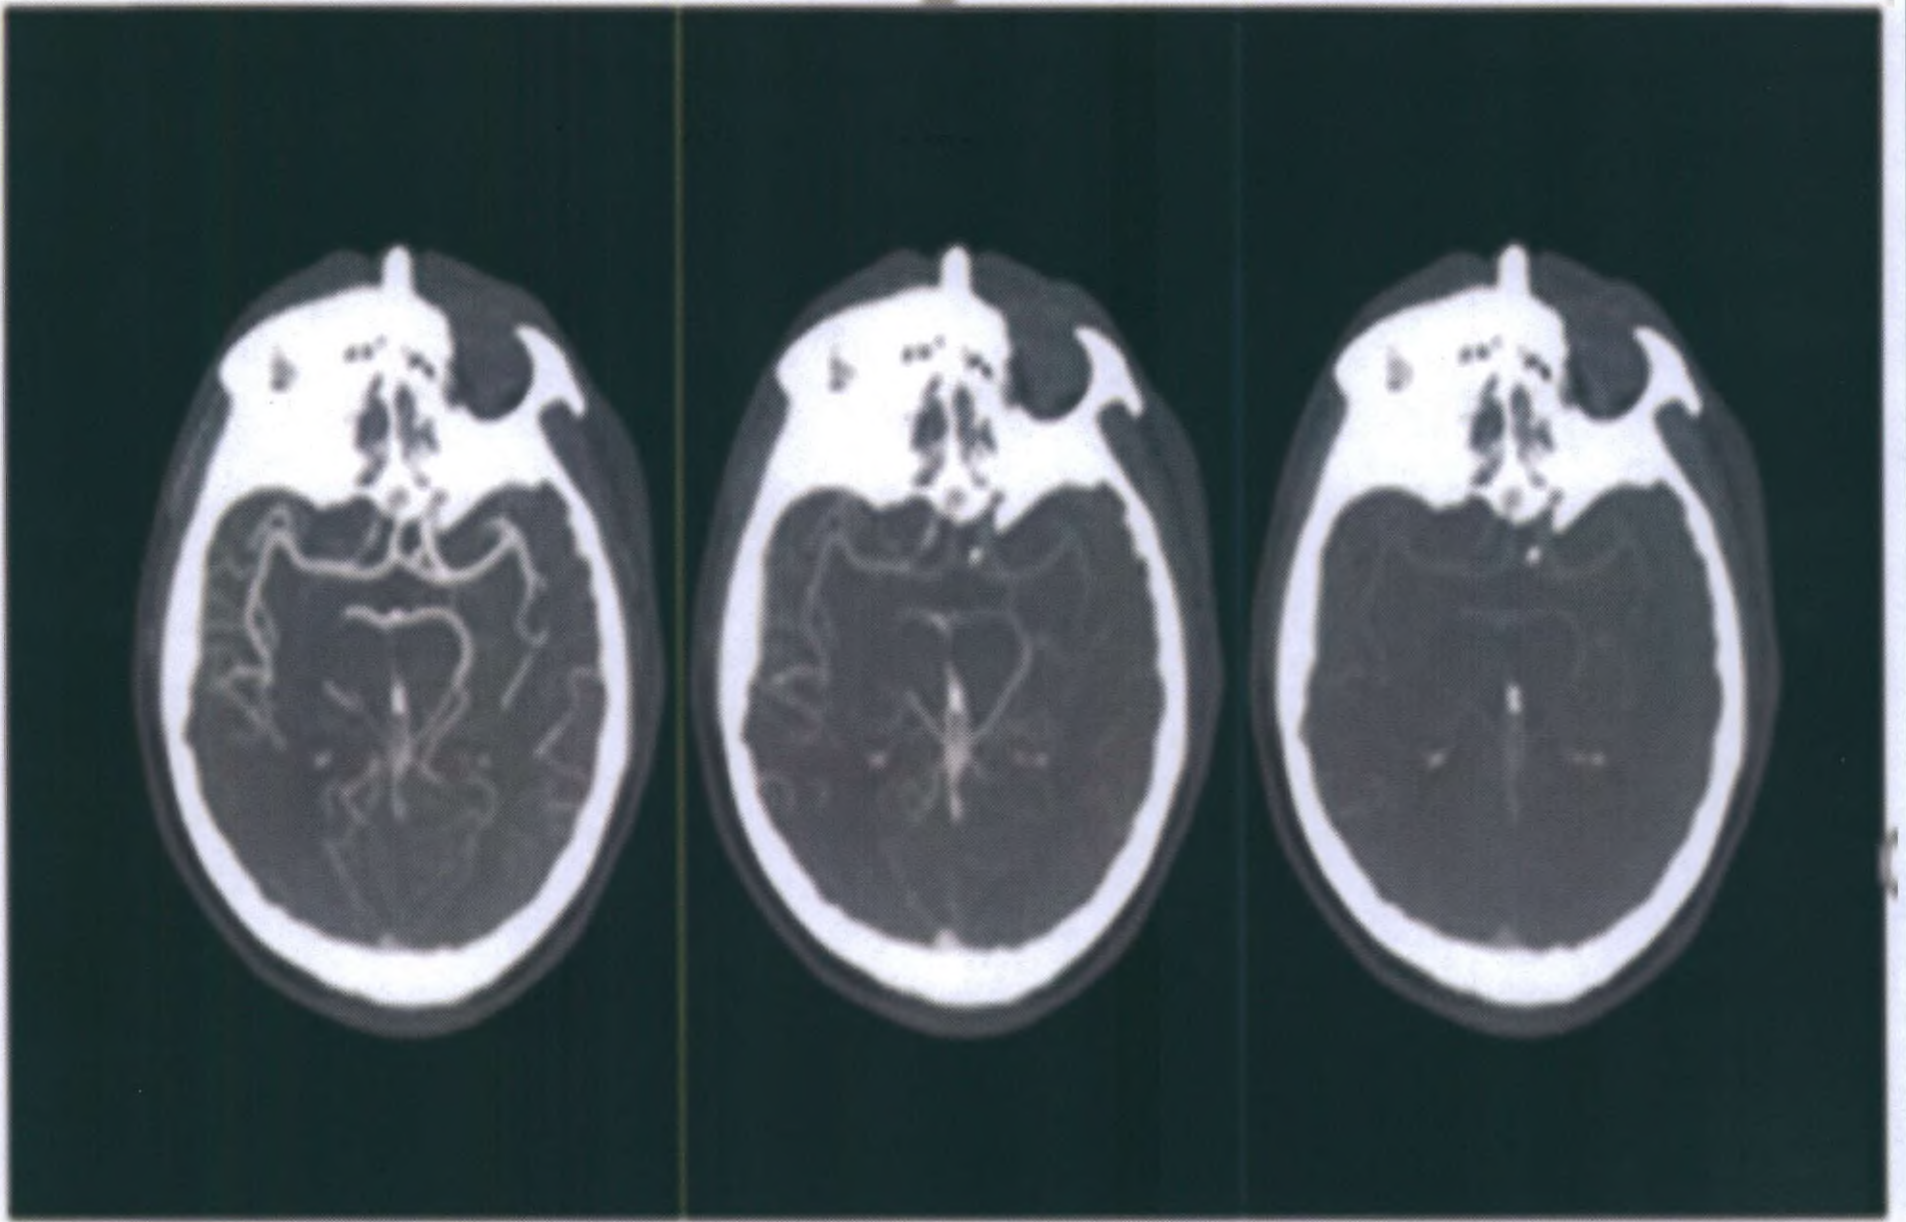


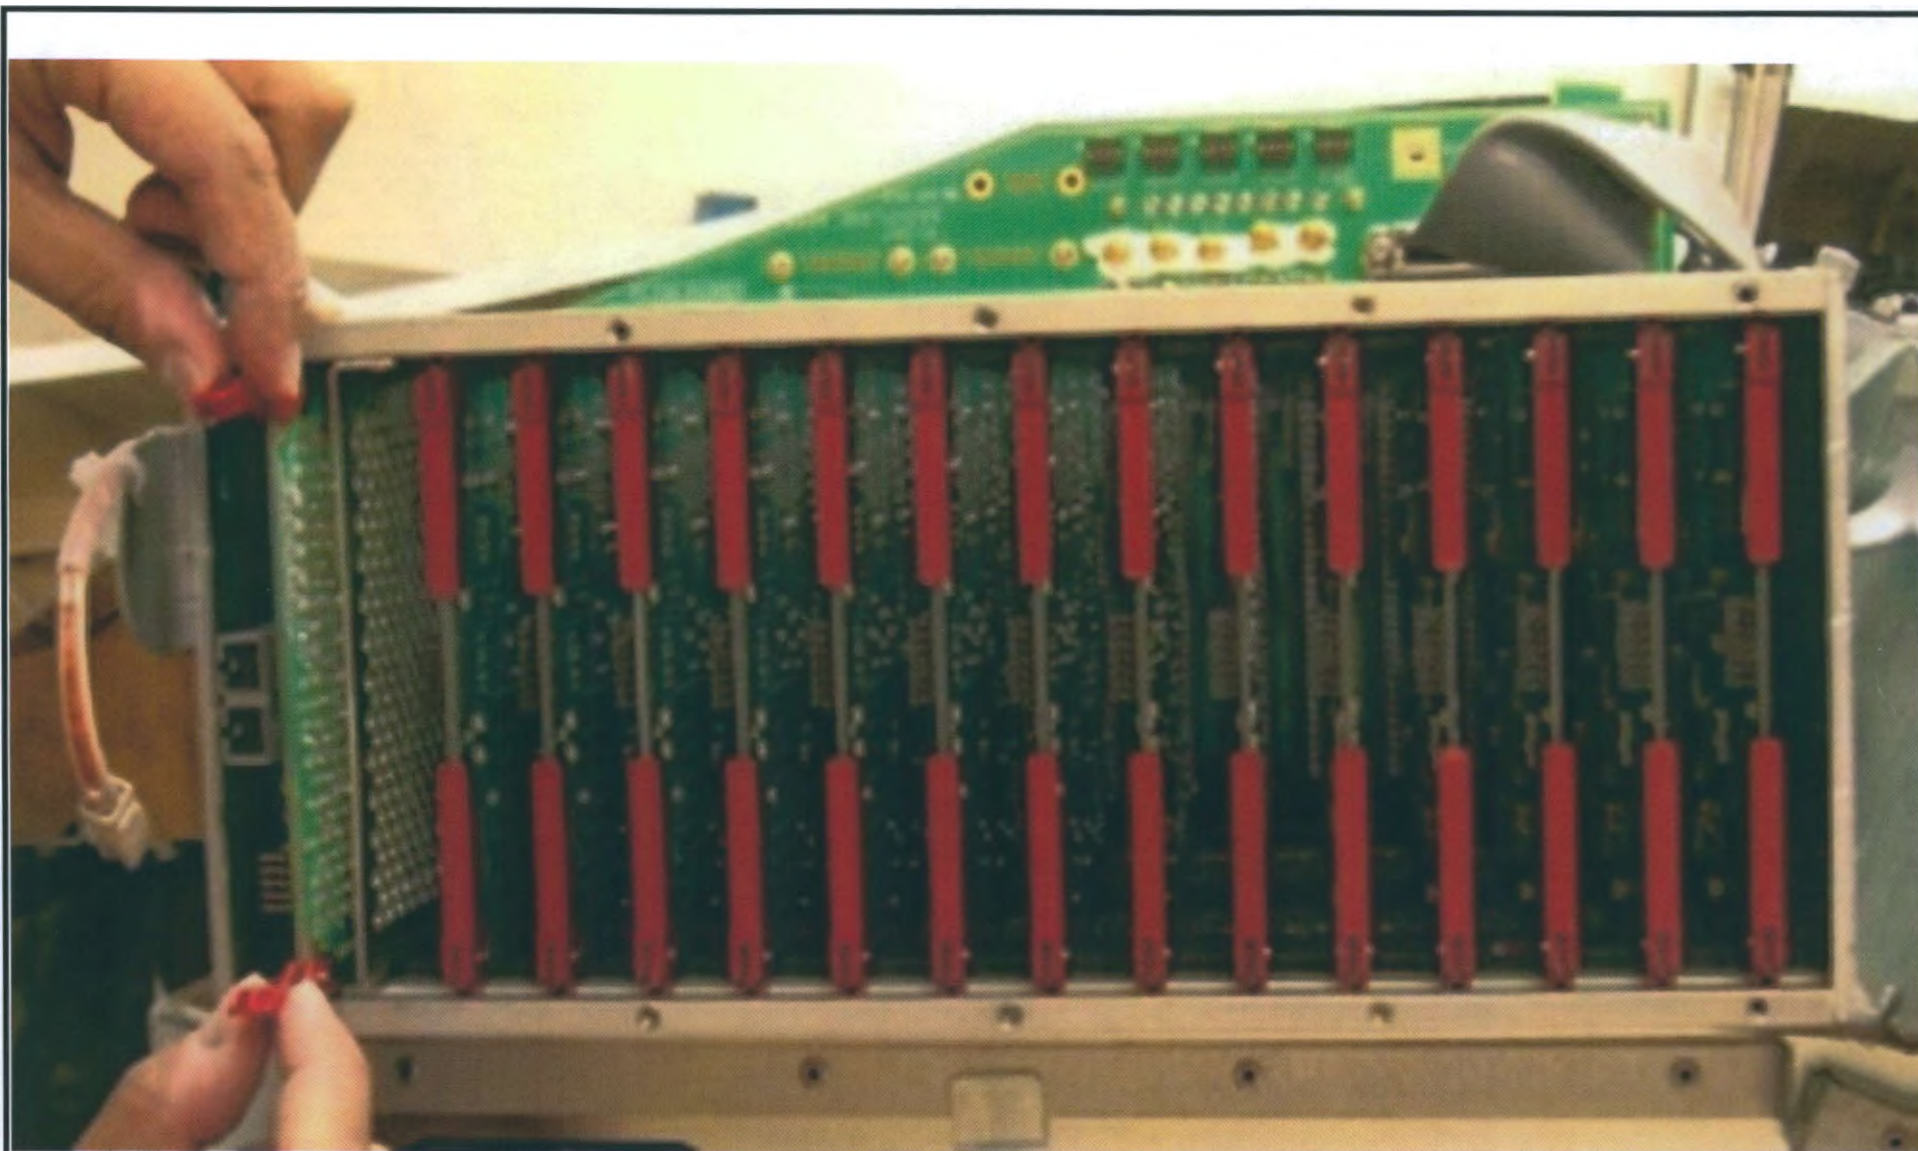

11. Блок охлаждения. (при необходимости)

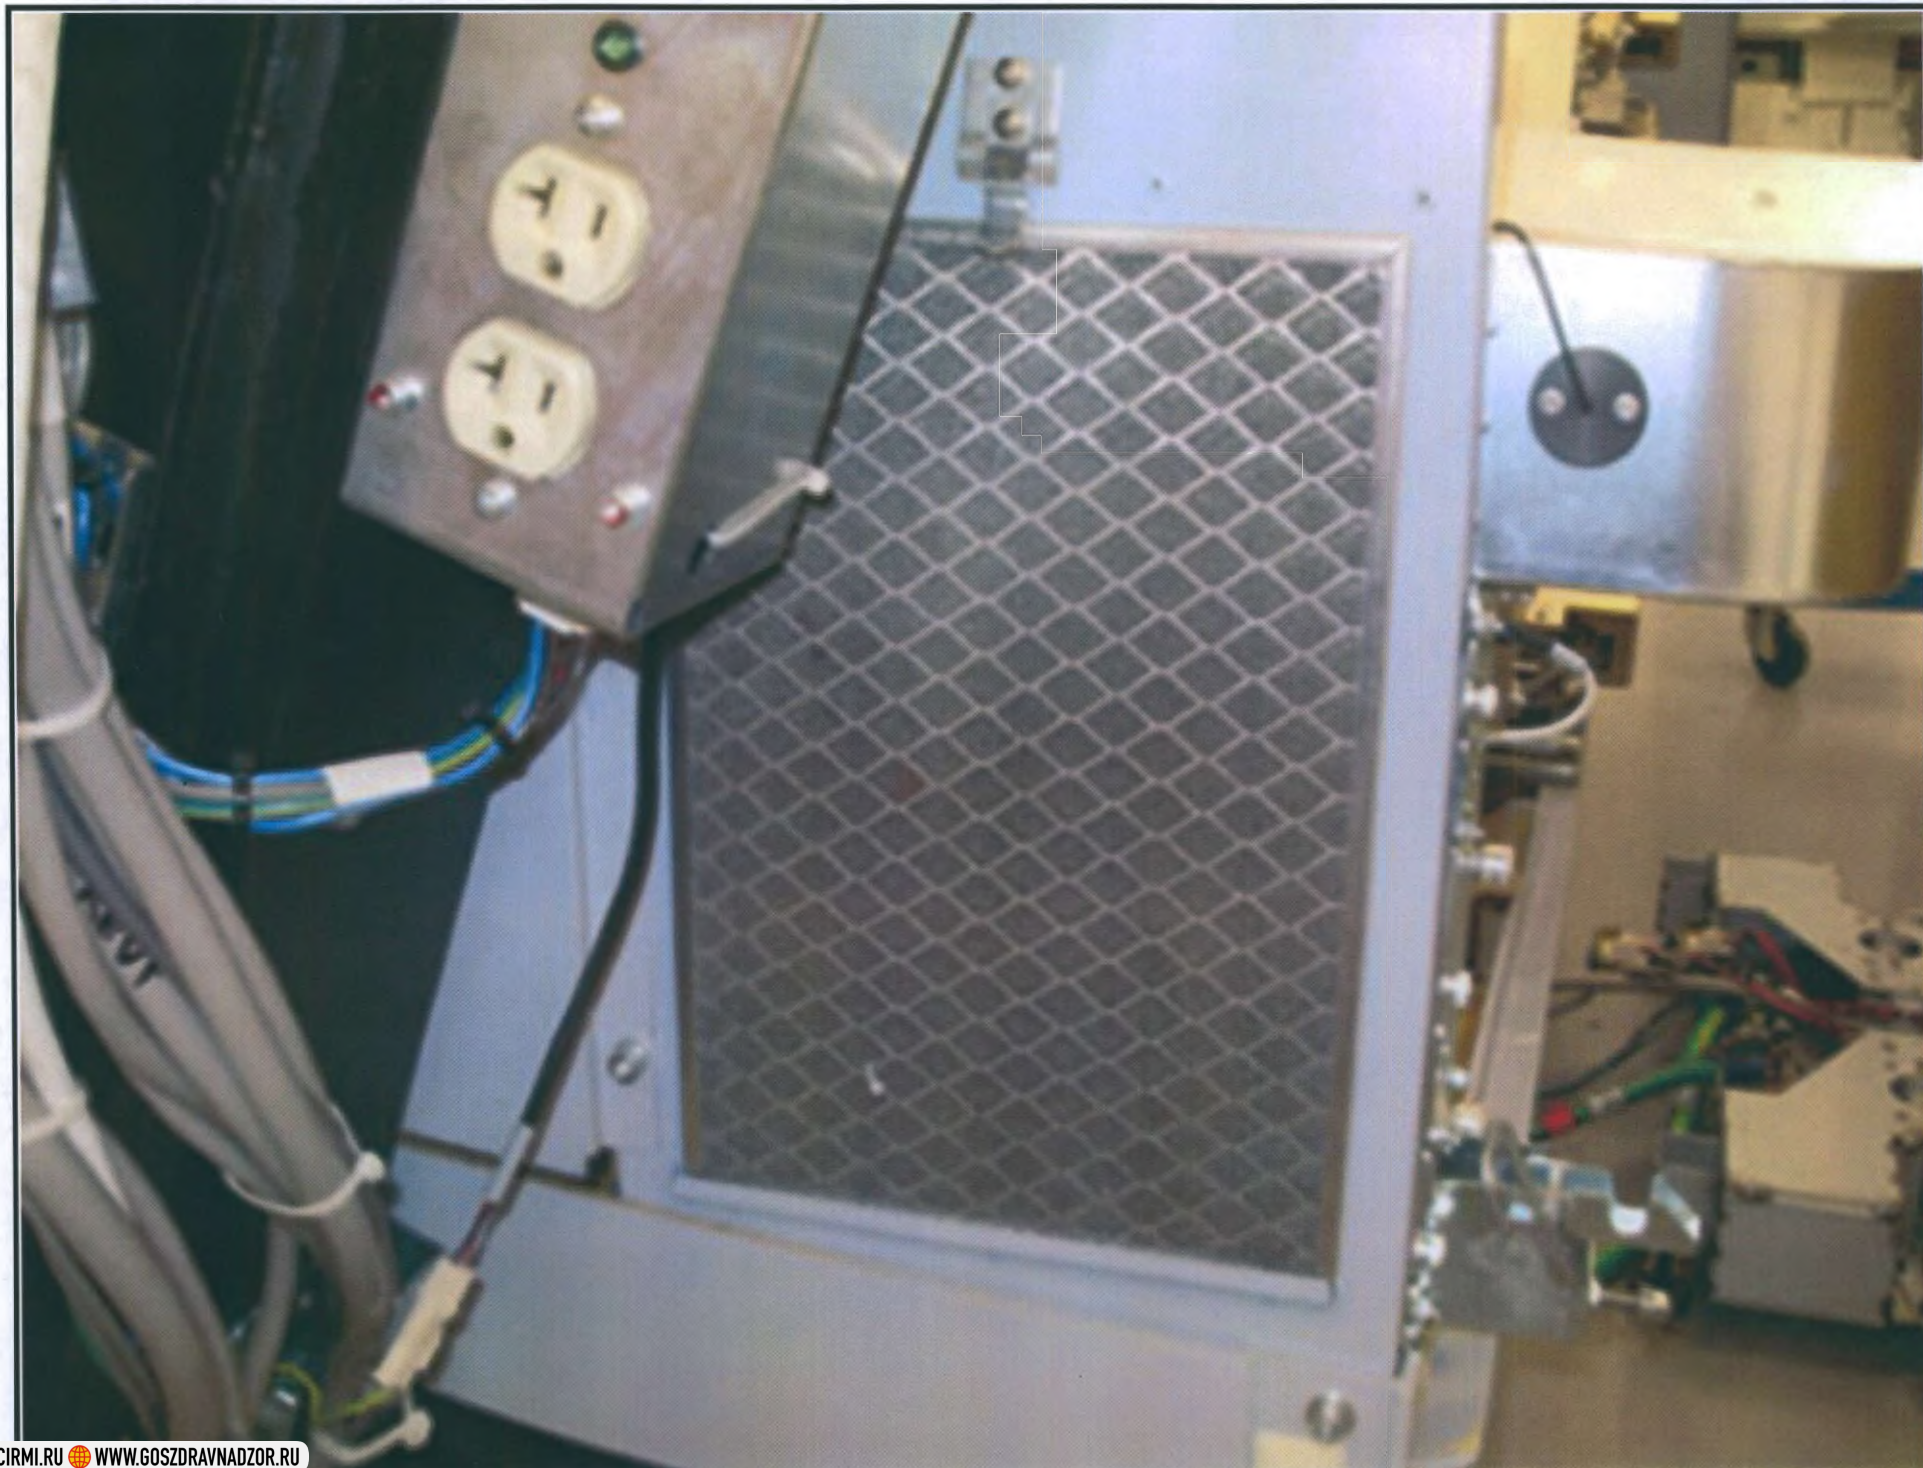

12. Устройство для синхронизации сканирования с дыханием пациента (не более 5 шт.). (при необходимости)

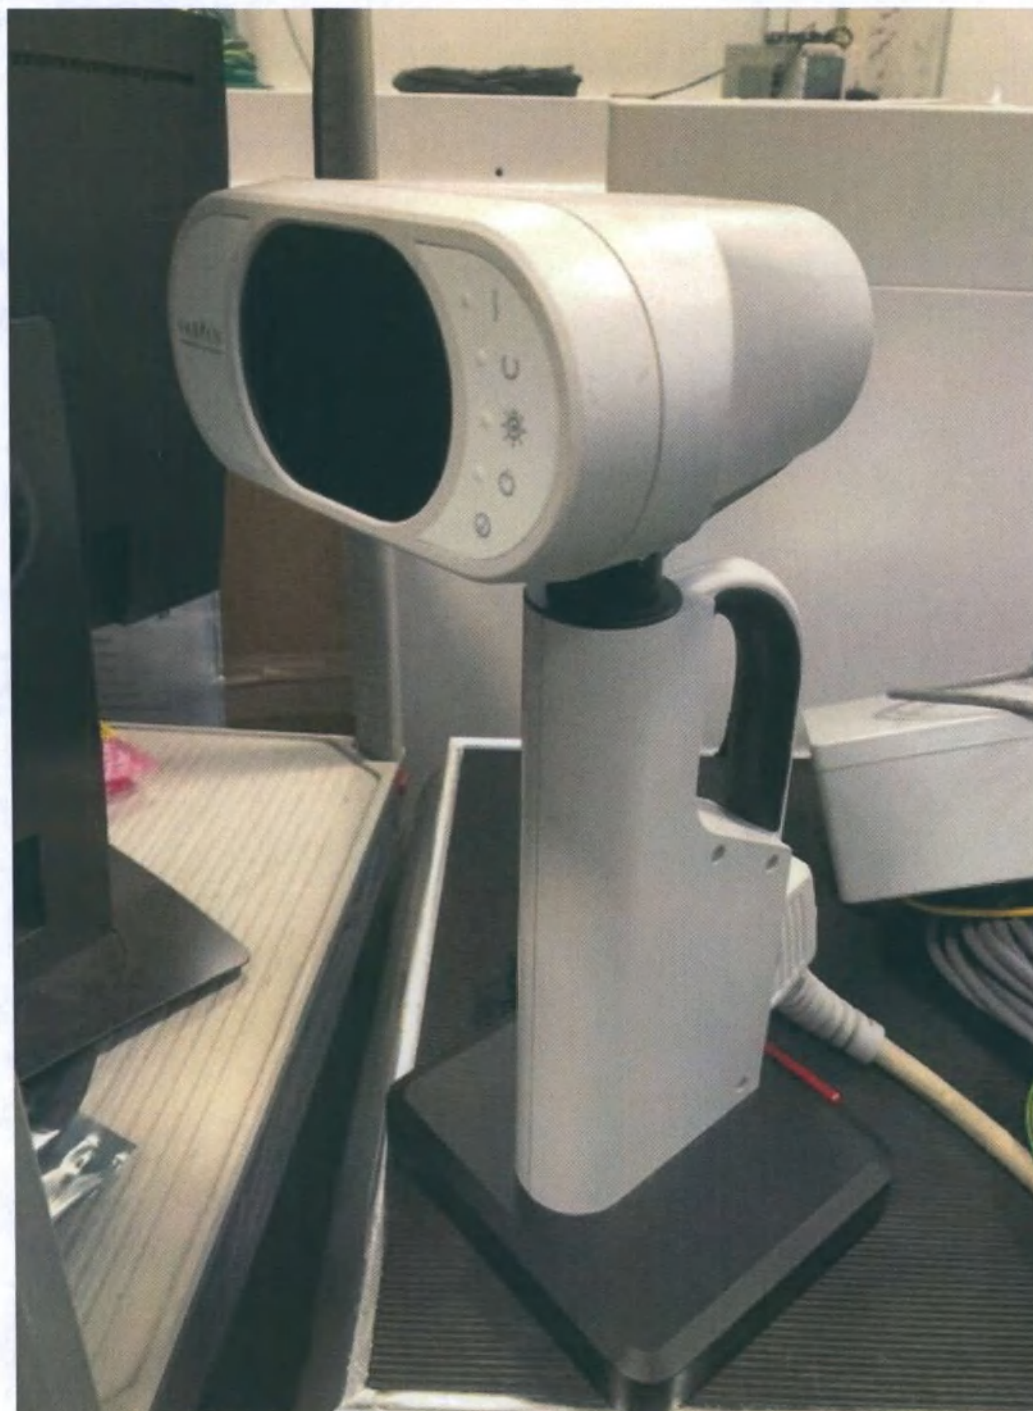

13. Техническое руководство (не более 10 шт.). (при необходимости)

Revolution™ CT, Revolution™ CT ES
Справочно-техническое руководство



5862804-1RU
Редакция 3
© 2022 General Electric Company
*Trademark of General Electric Company


14. Руководство пользователя (не более 5 шт.).

Revolution™ CT, Revolution™ CT ES
Руководство пользователя



5862803-1RU
Редакция 3
© 2022 General Electric Company
*Trademark of General Electric Company

15. Эксплуатационная документация (не более 10 шт.). (при необходимости)

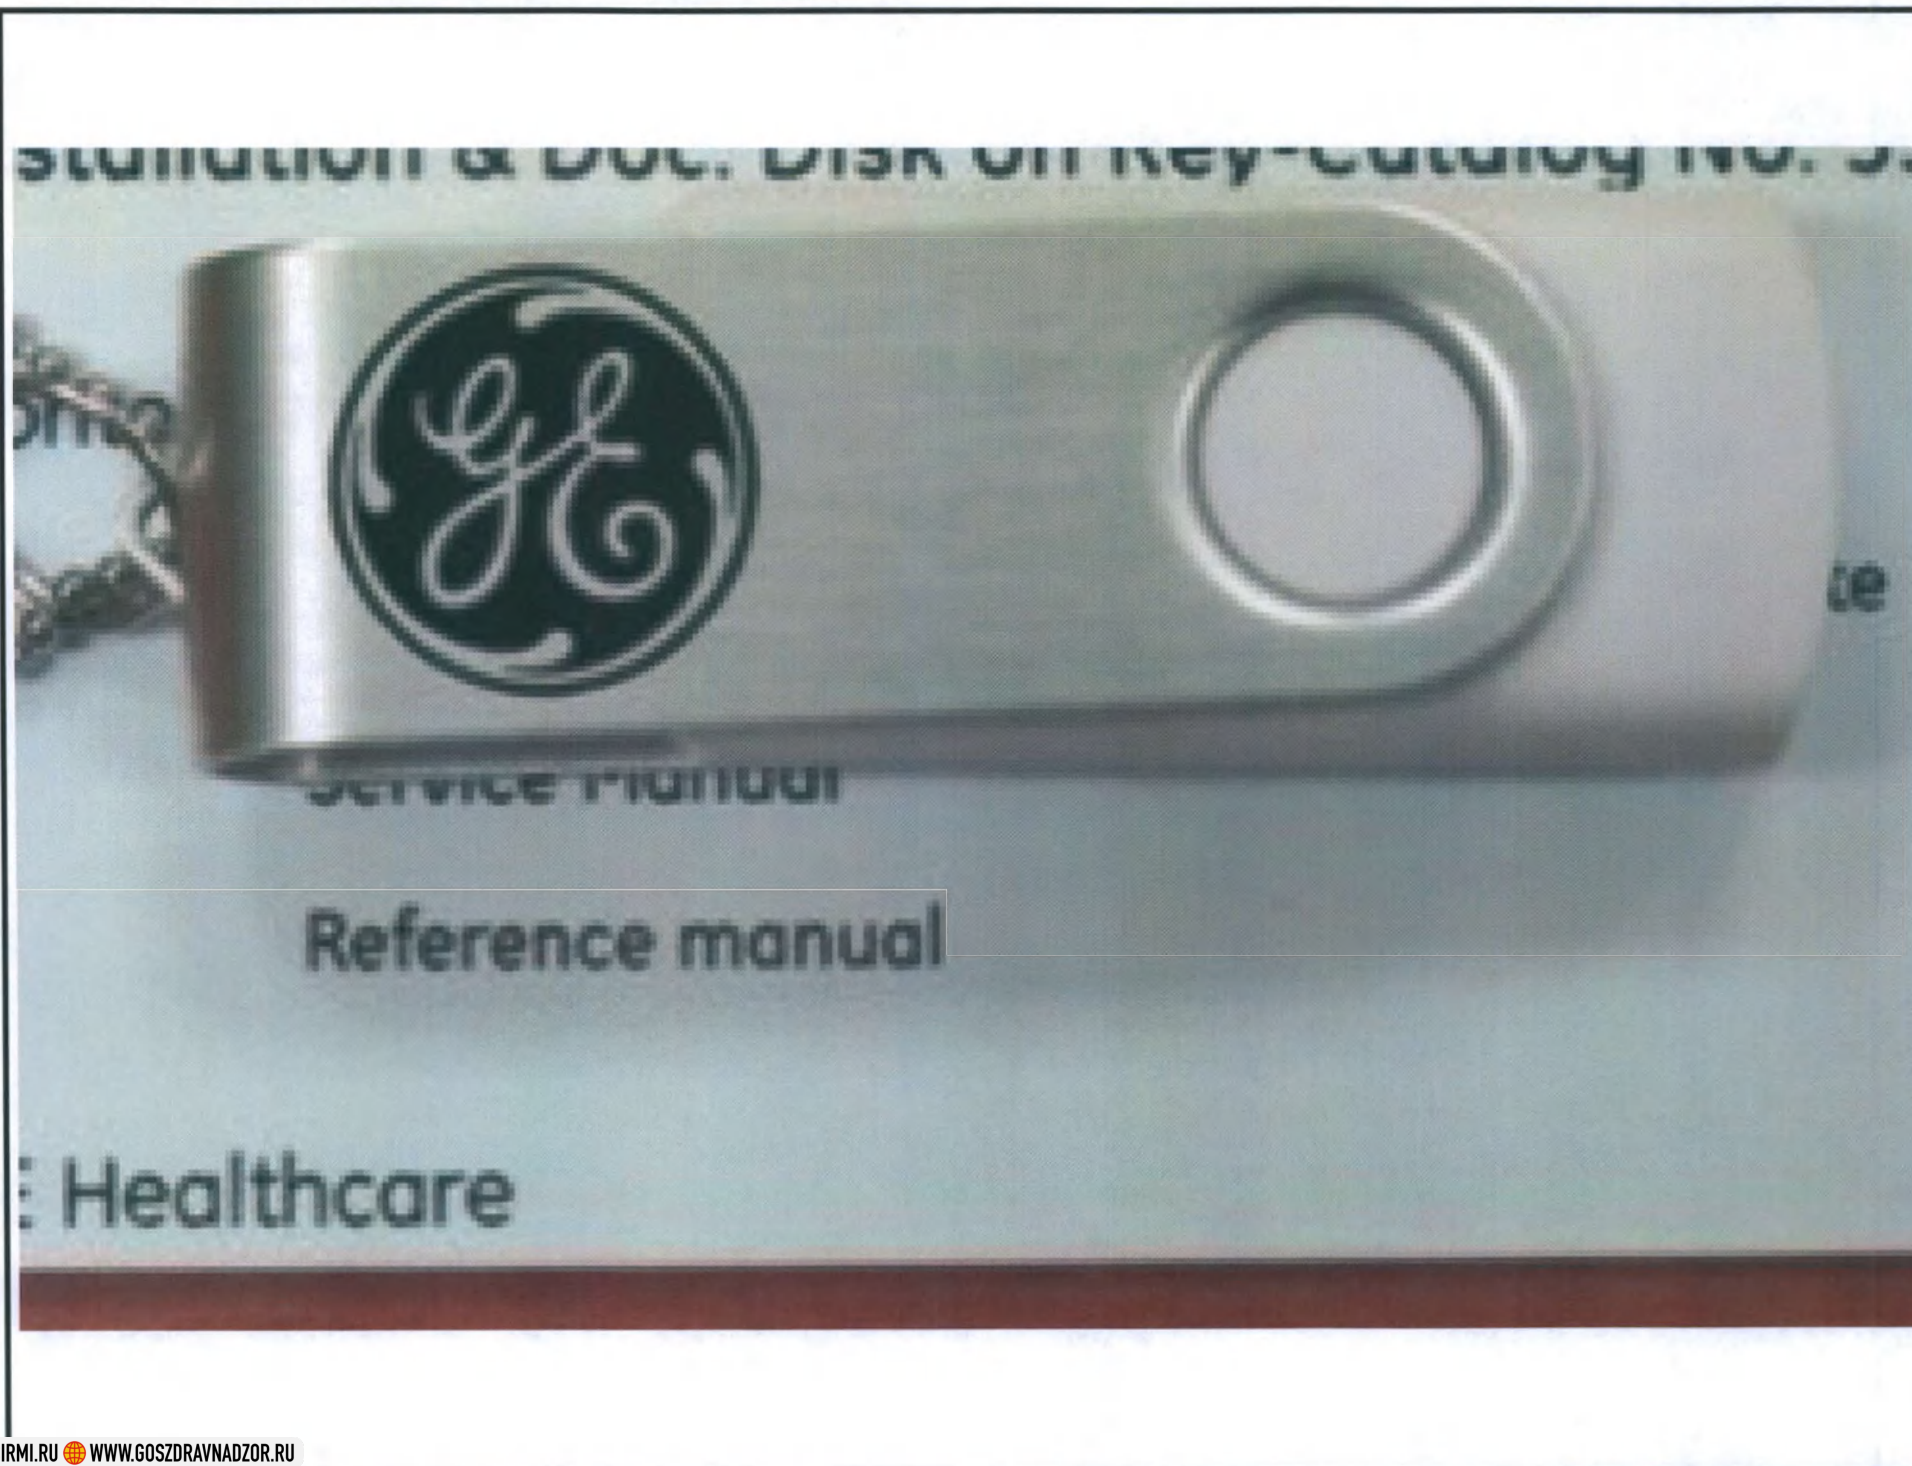







2. Рабочий стол оператора.



3. Пульт управления оператора.



4. Пульт дистанционного управления.




5. Экран сенсорный. (не более 5 шт.).




6. Шкаф силовой электрический .




7. Модуль памяти (не более 15 шт.).

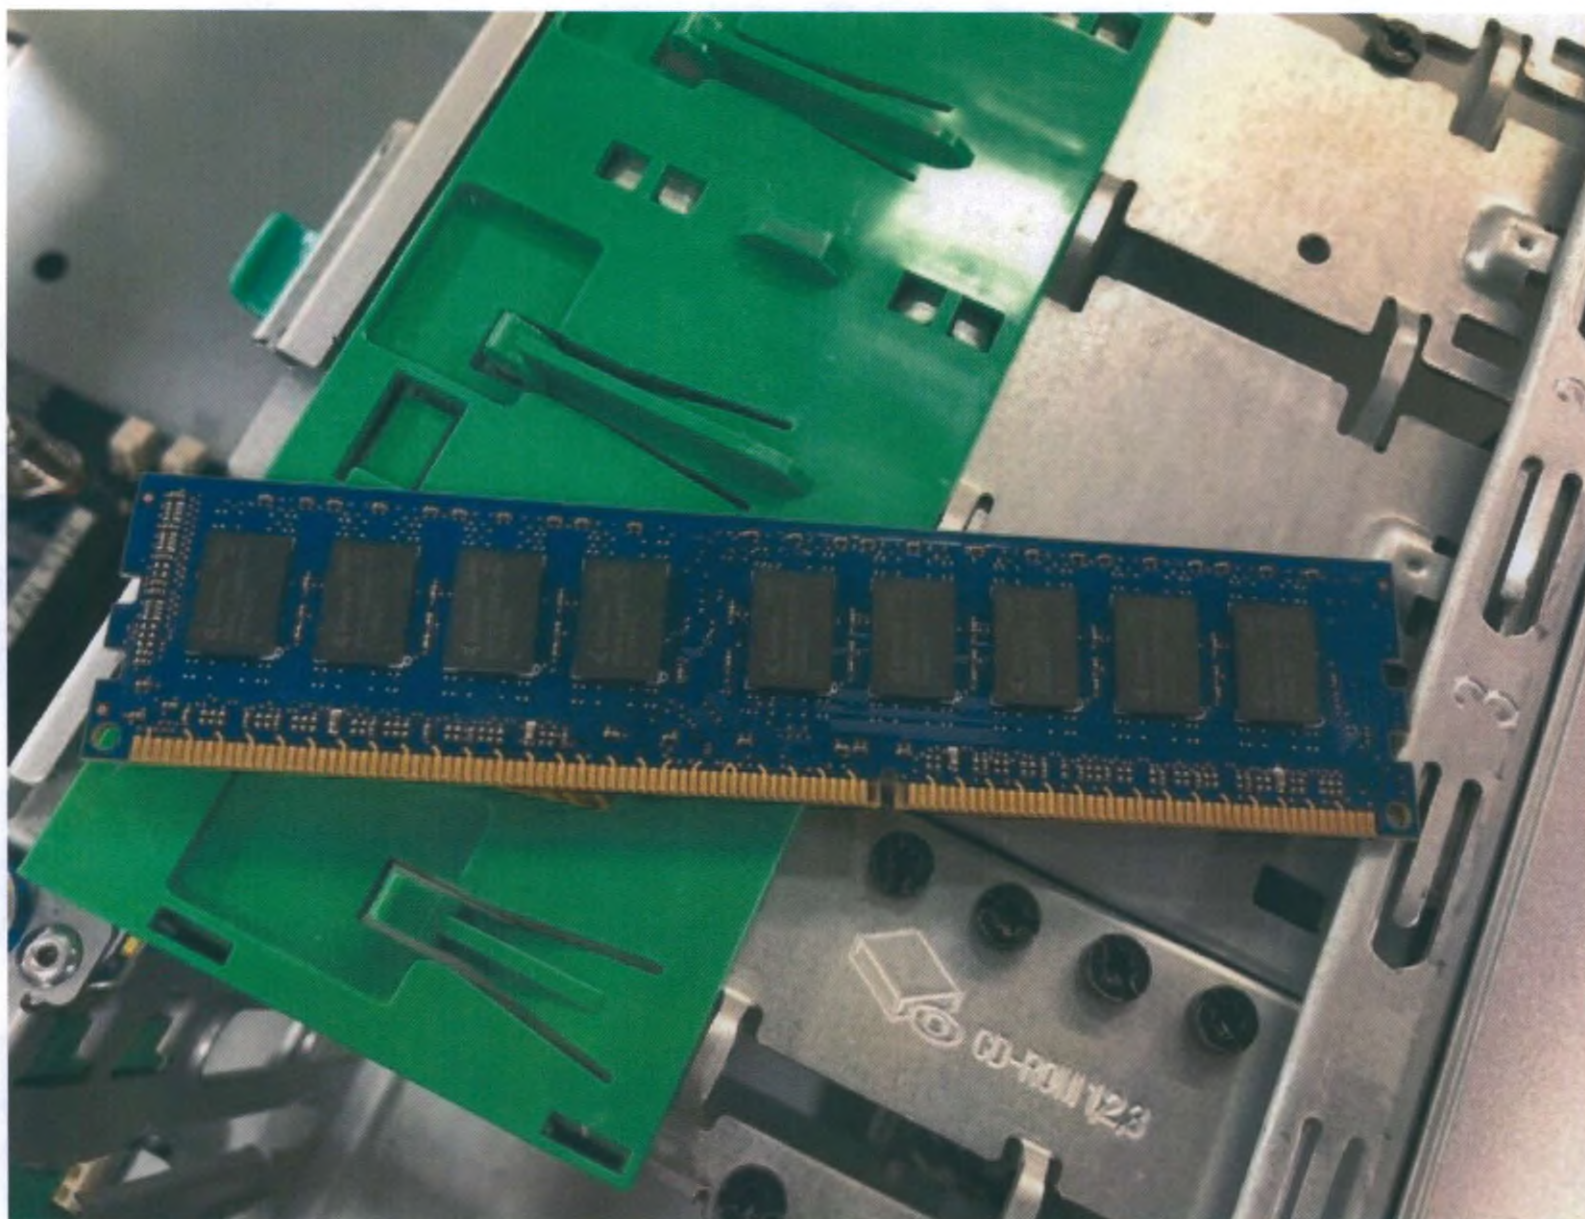


8. Фильтры воздушные (не более 10 шт.).

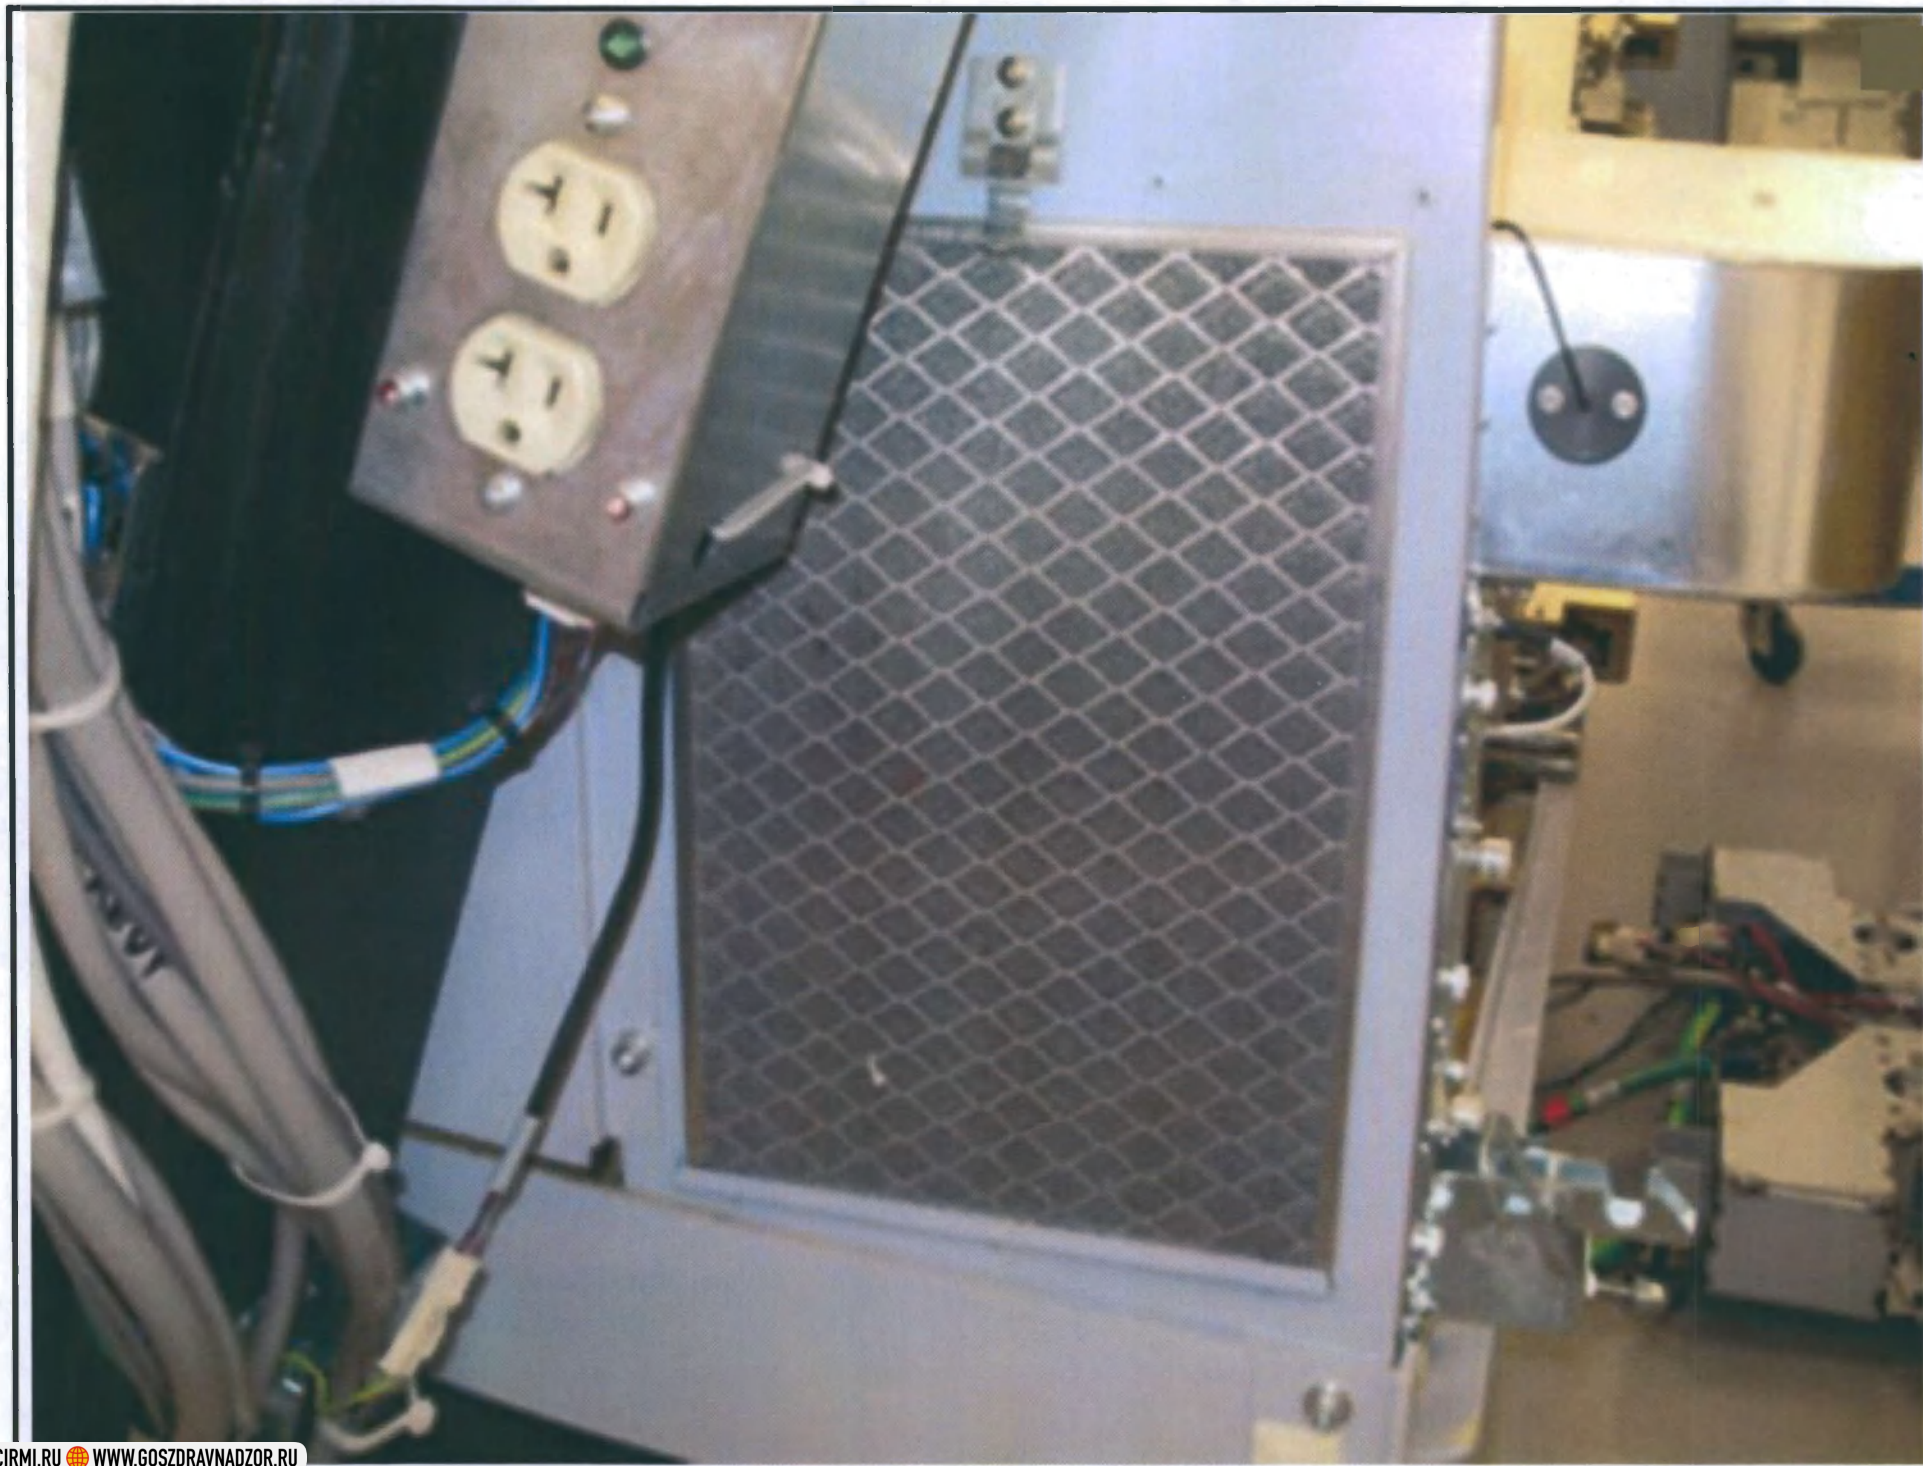


9. Фильтры электро-помехоподавляющие (не более 10 шт.).

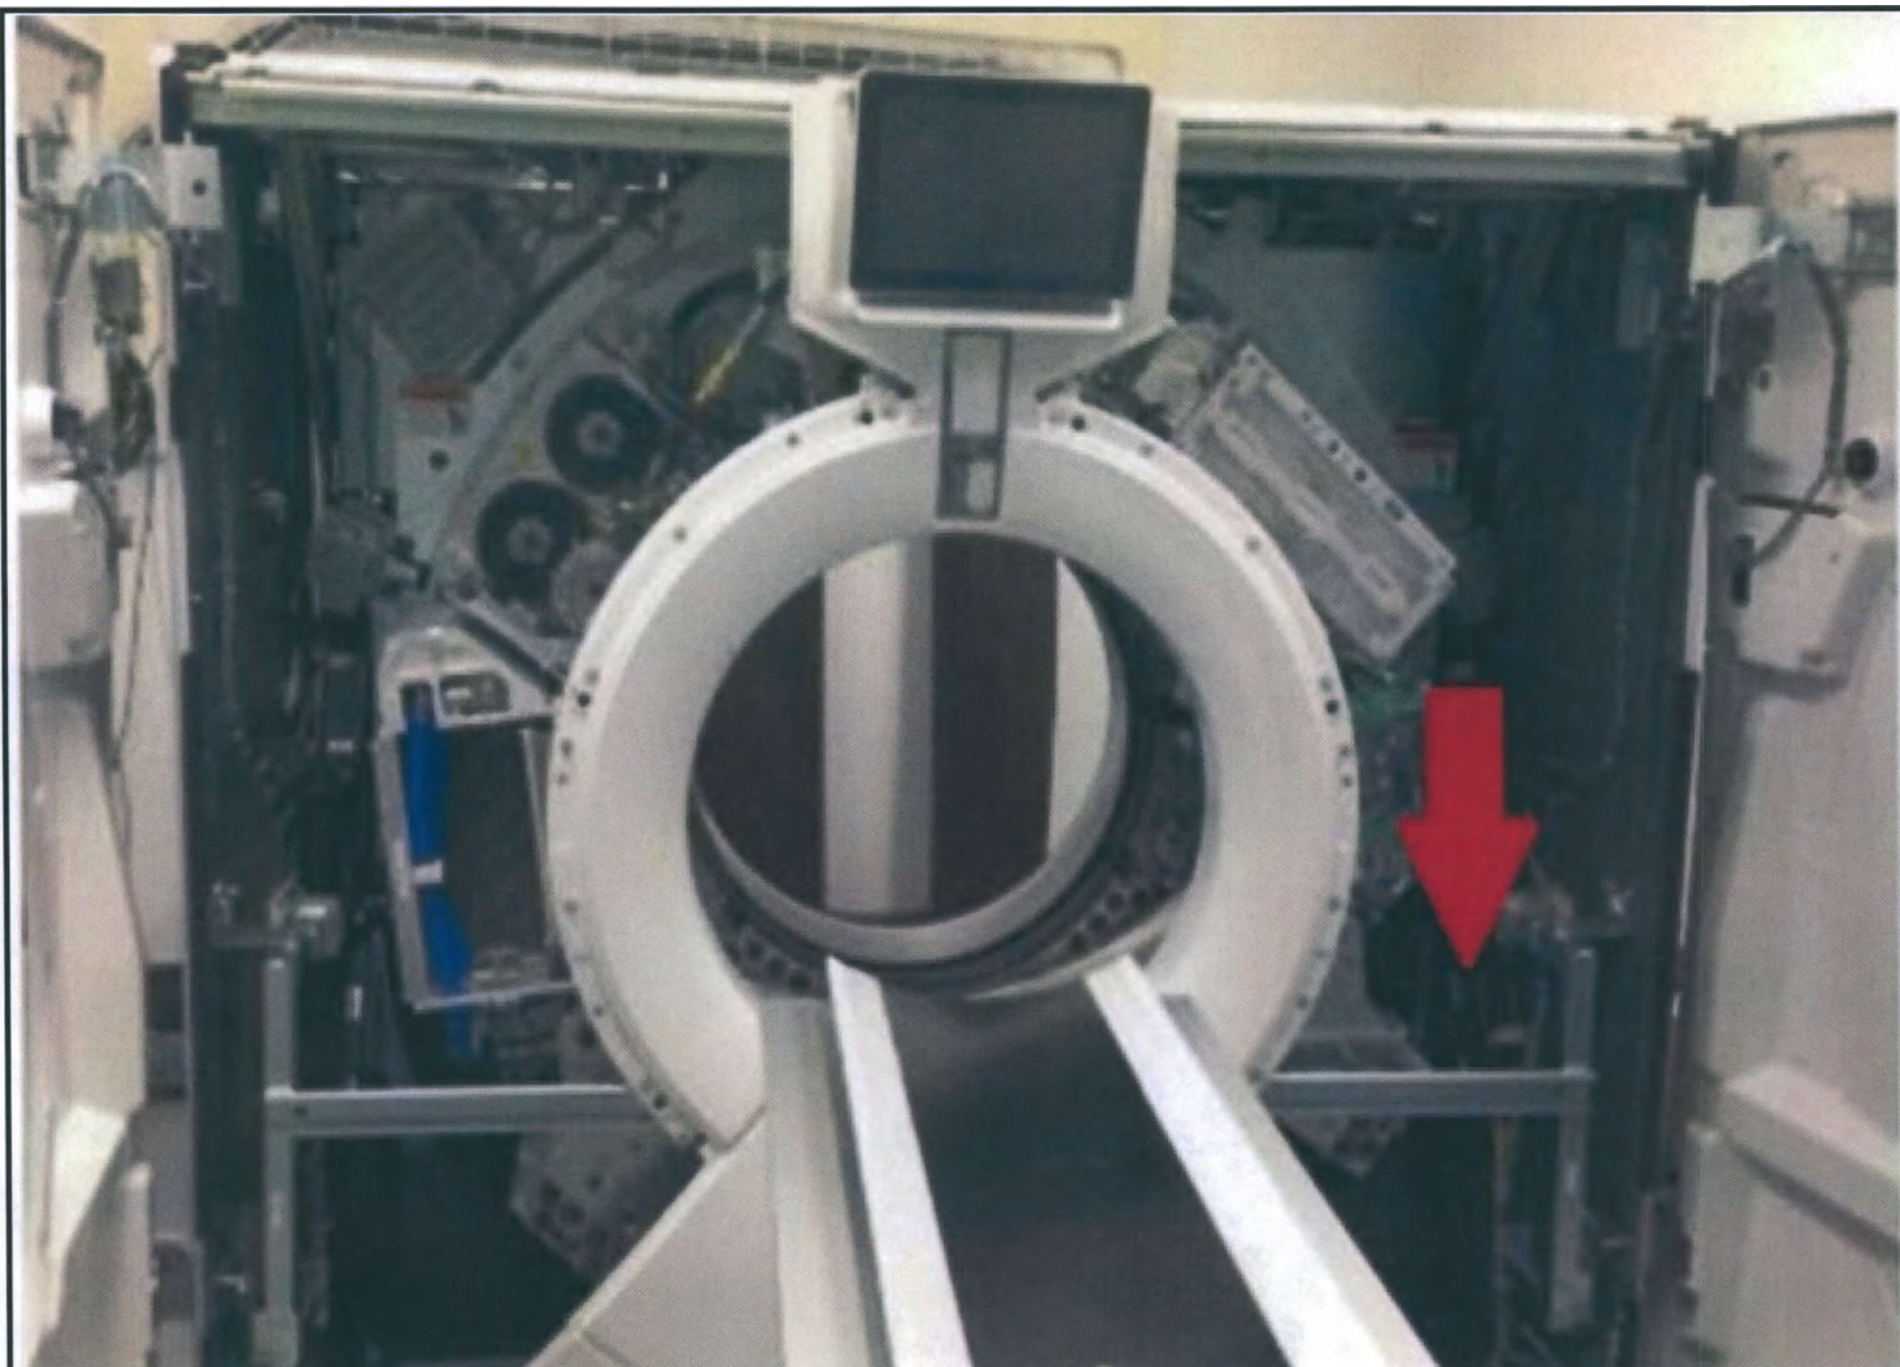


9. Фильтры электро-помехоподавляющие (не более 10 шт.).

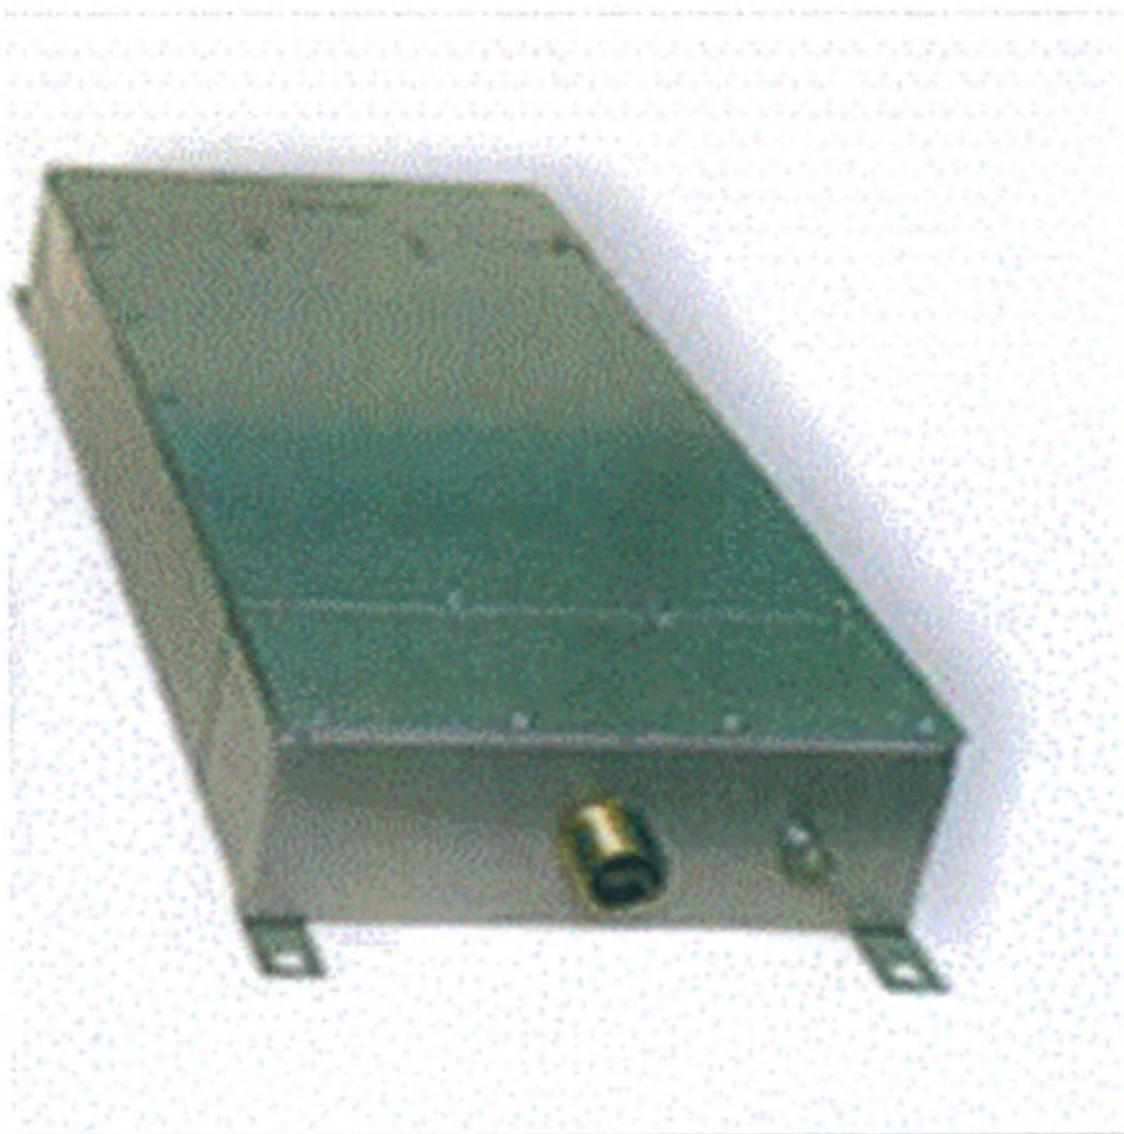

10. Фильтры формирования рентгеновского луча (не более 10 шт.).

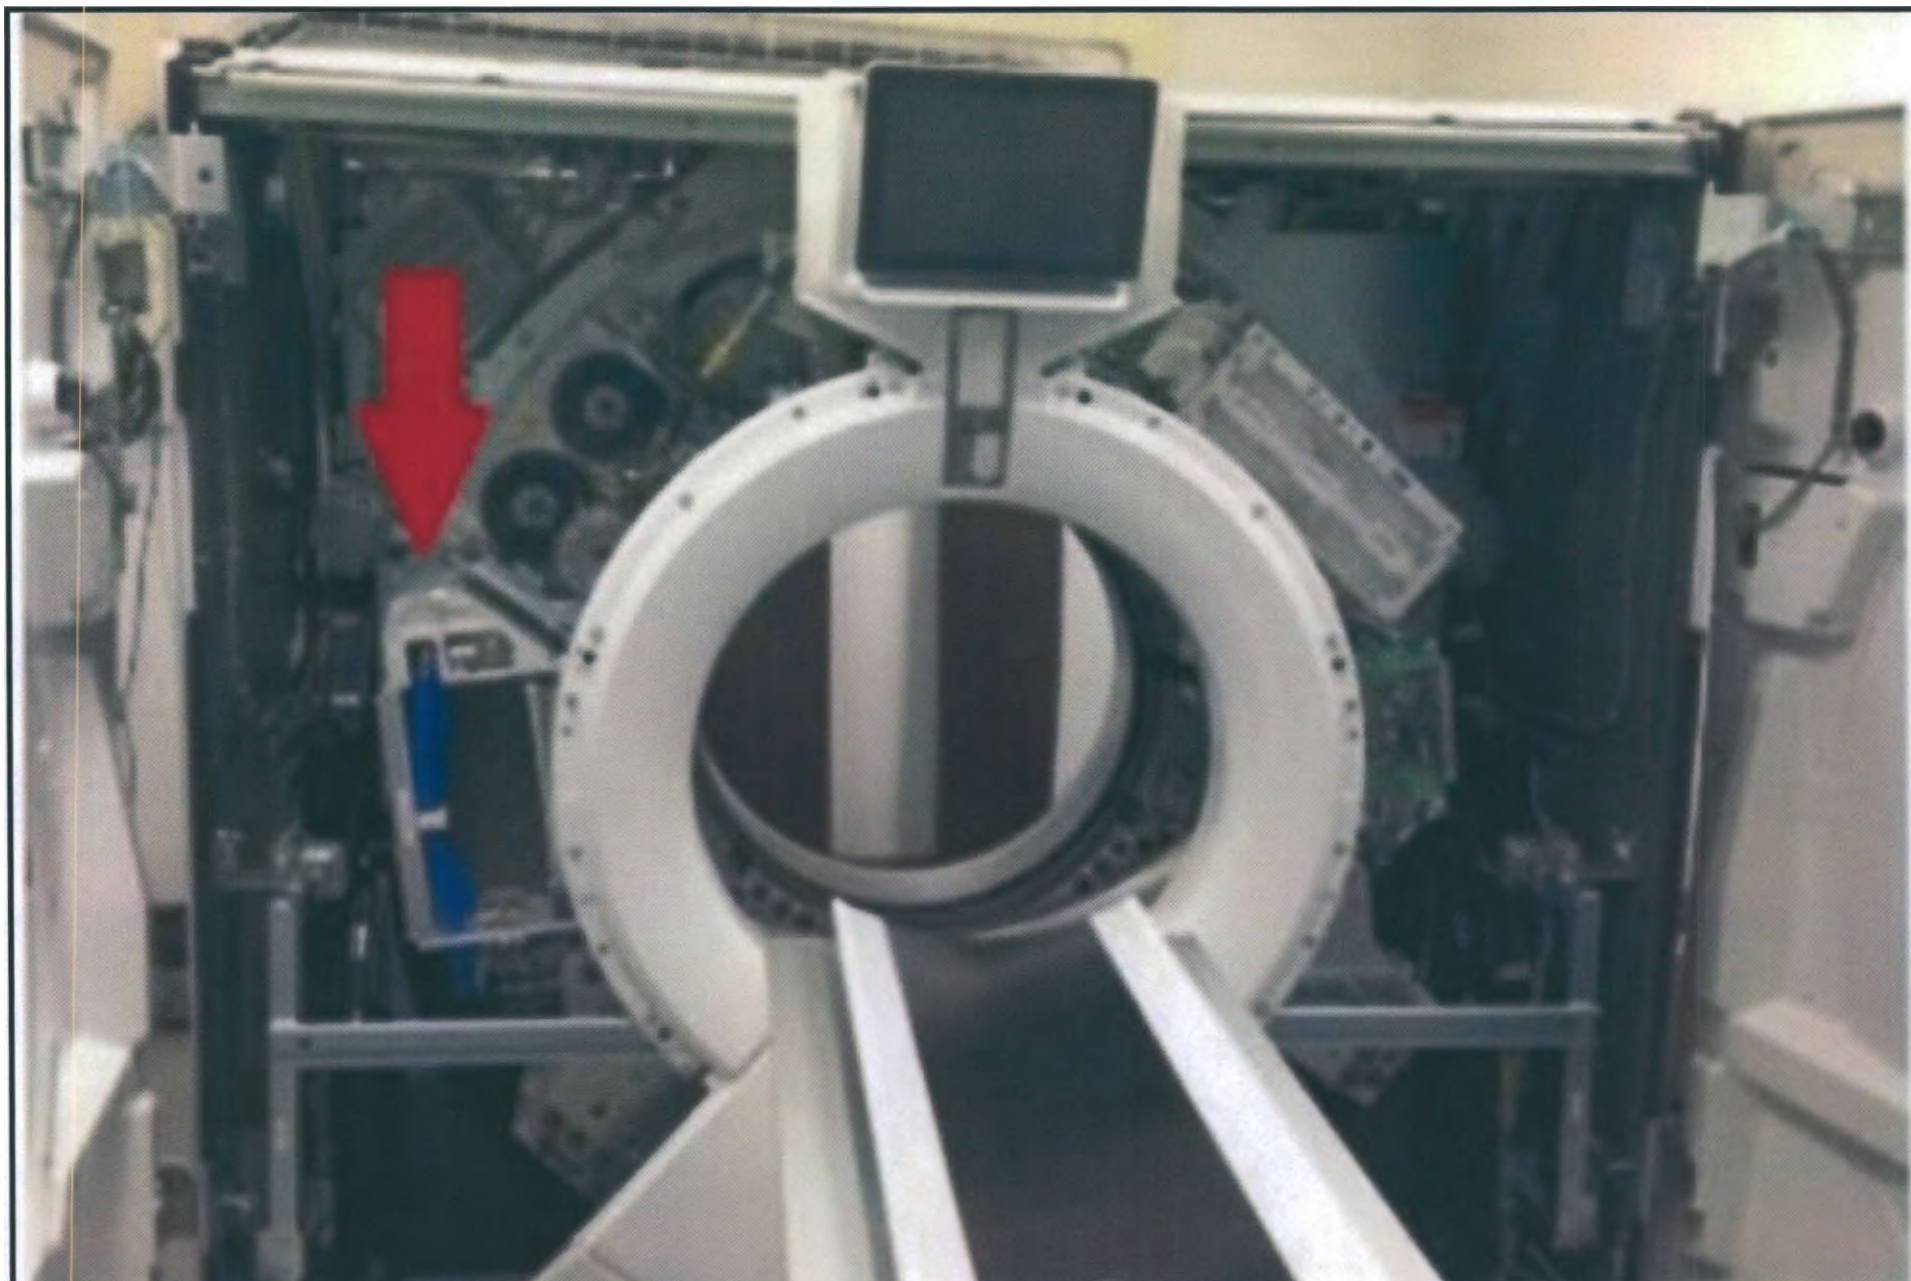


11. Защитные крышки гентри (не более 20 шт.)

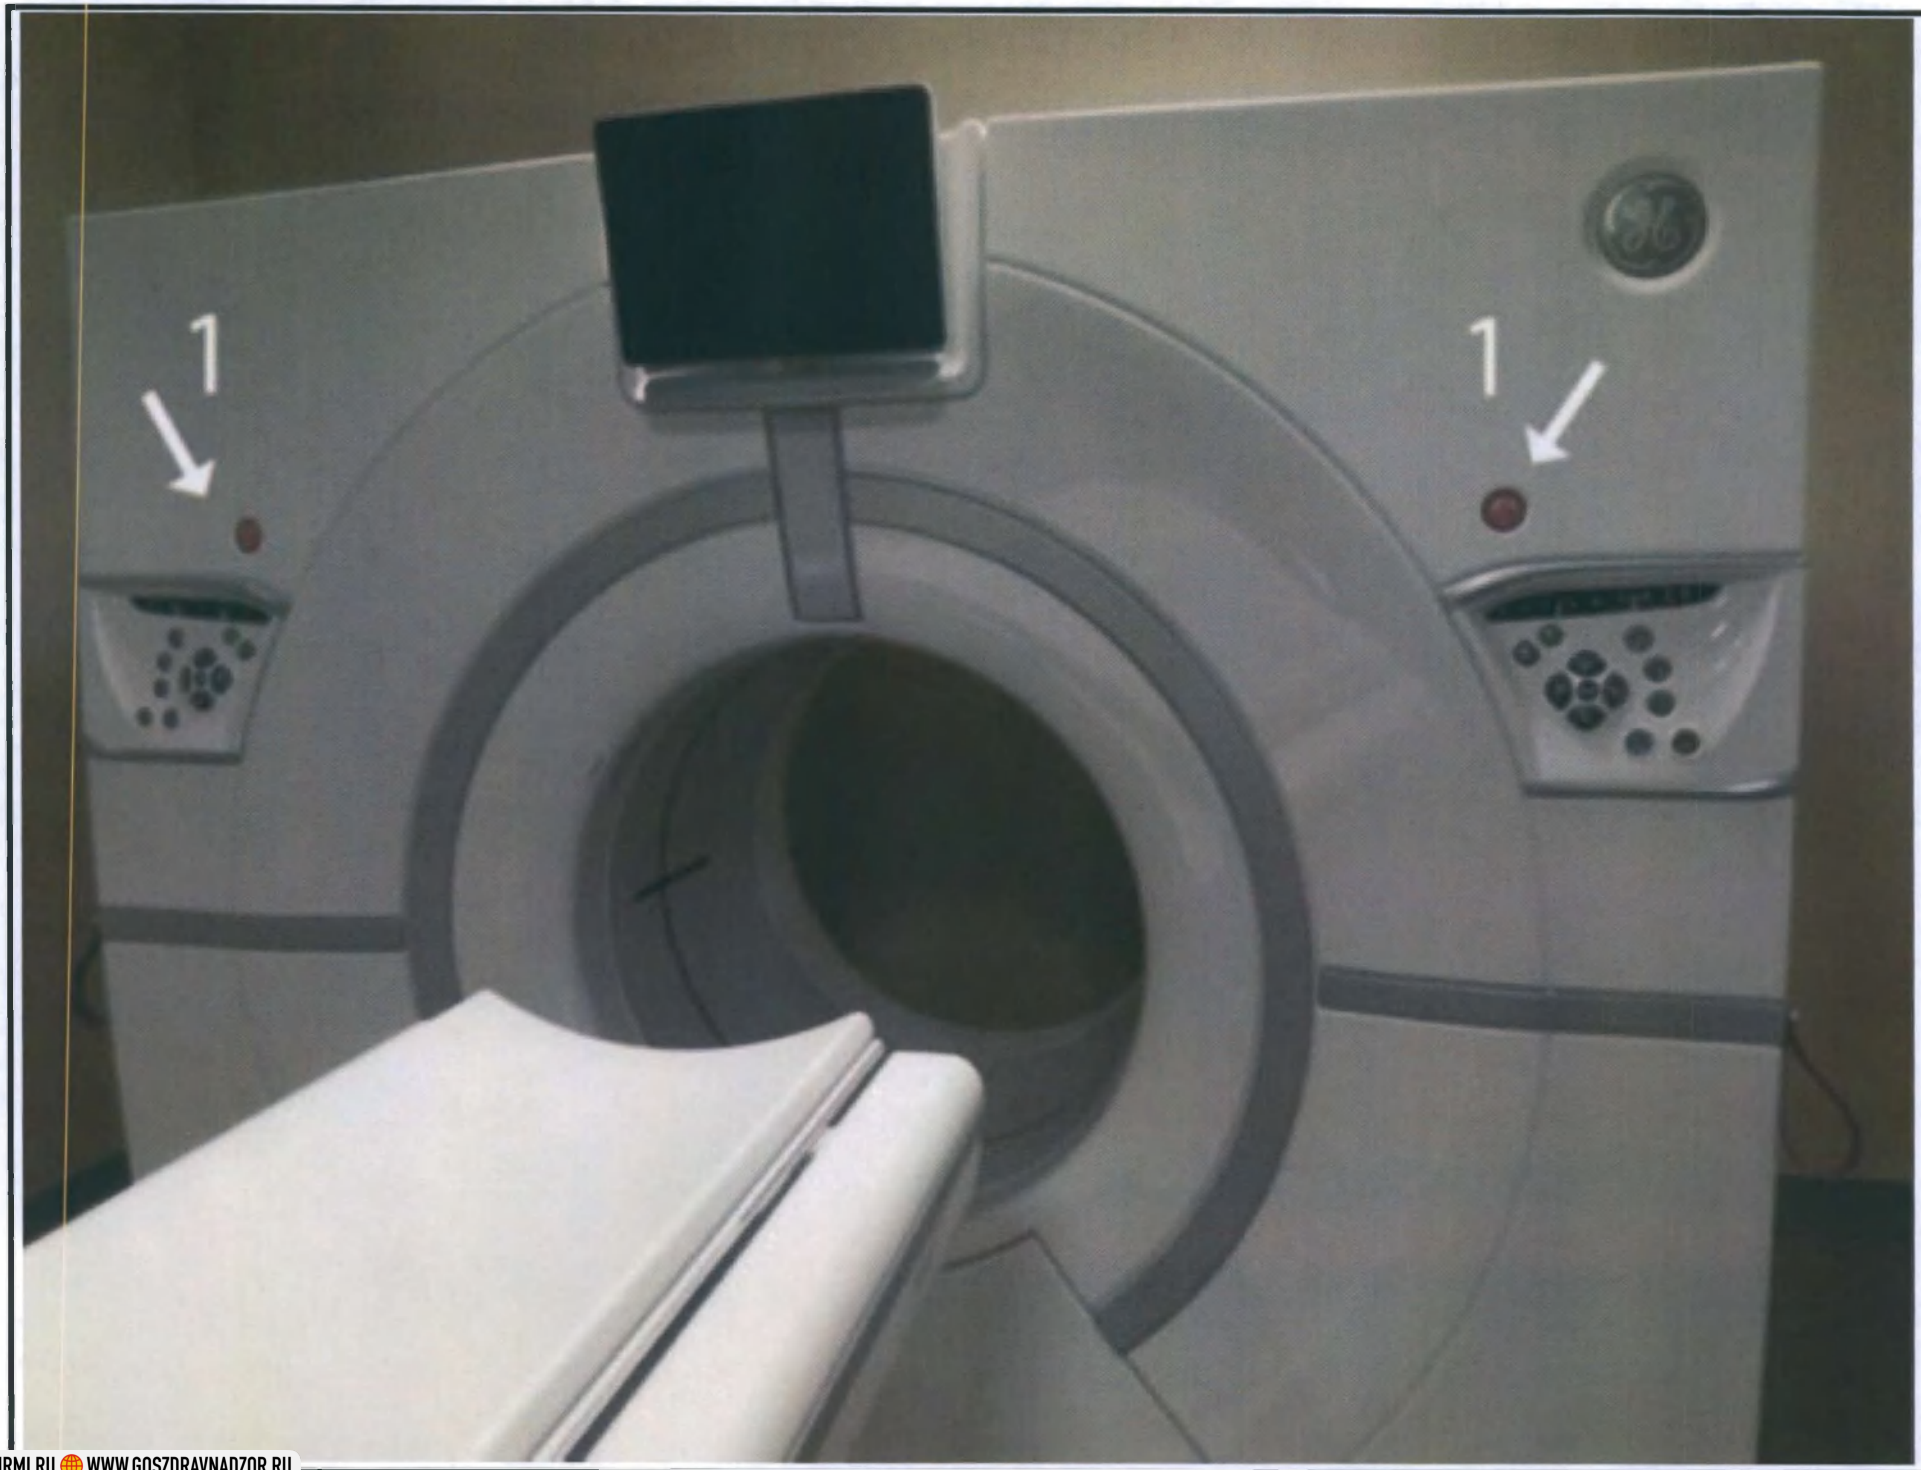


12. Декоративные крышки гентри (не более 20 шт.).



13. Декоративные крышки стола пациента (не более 20 шт.).

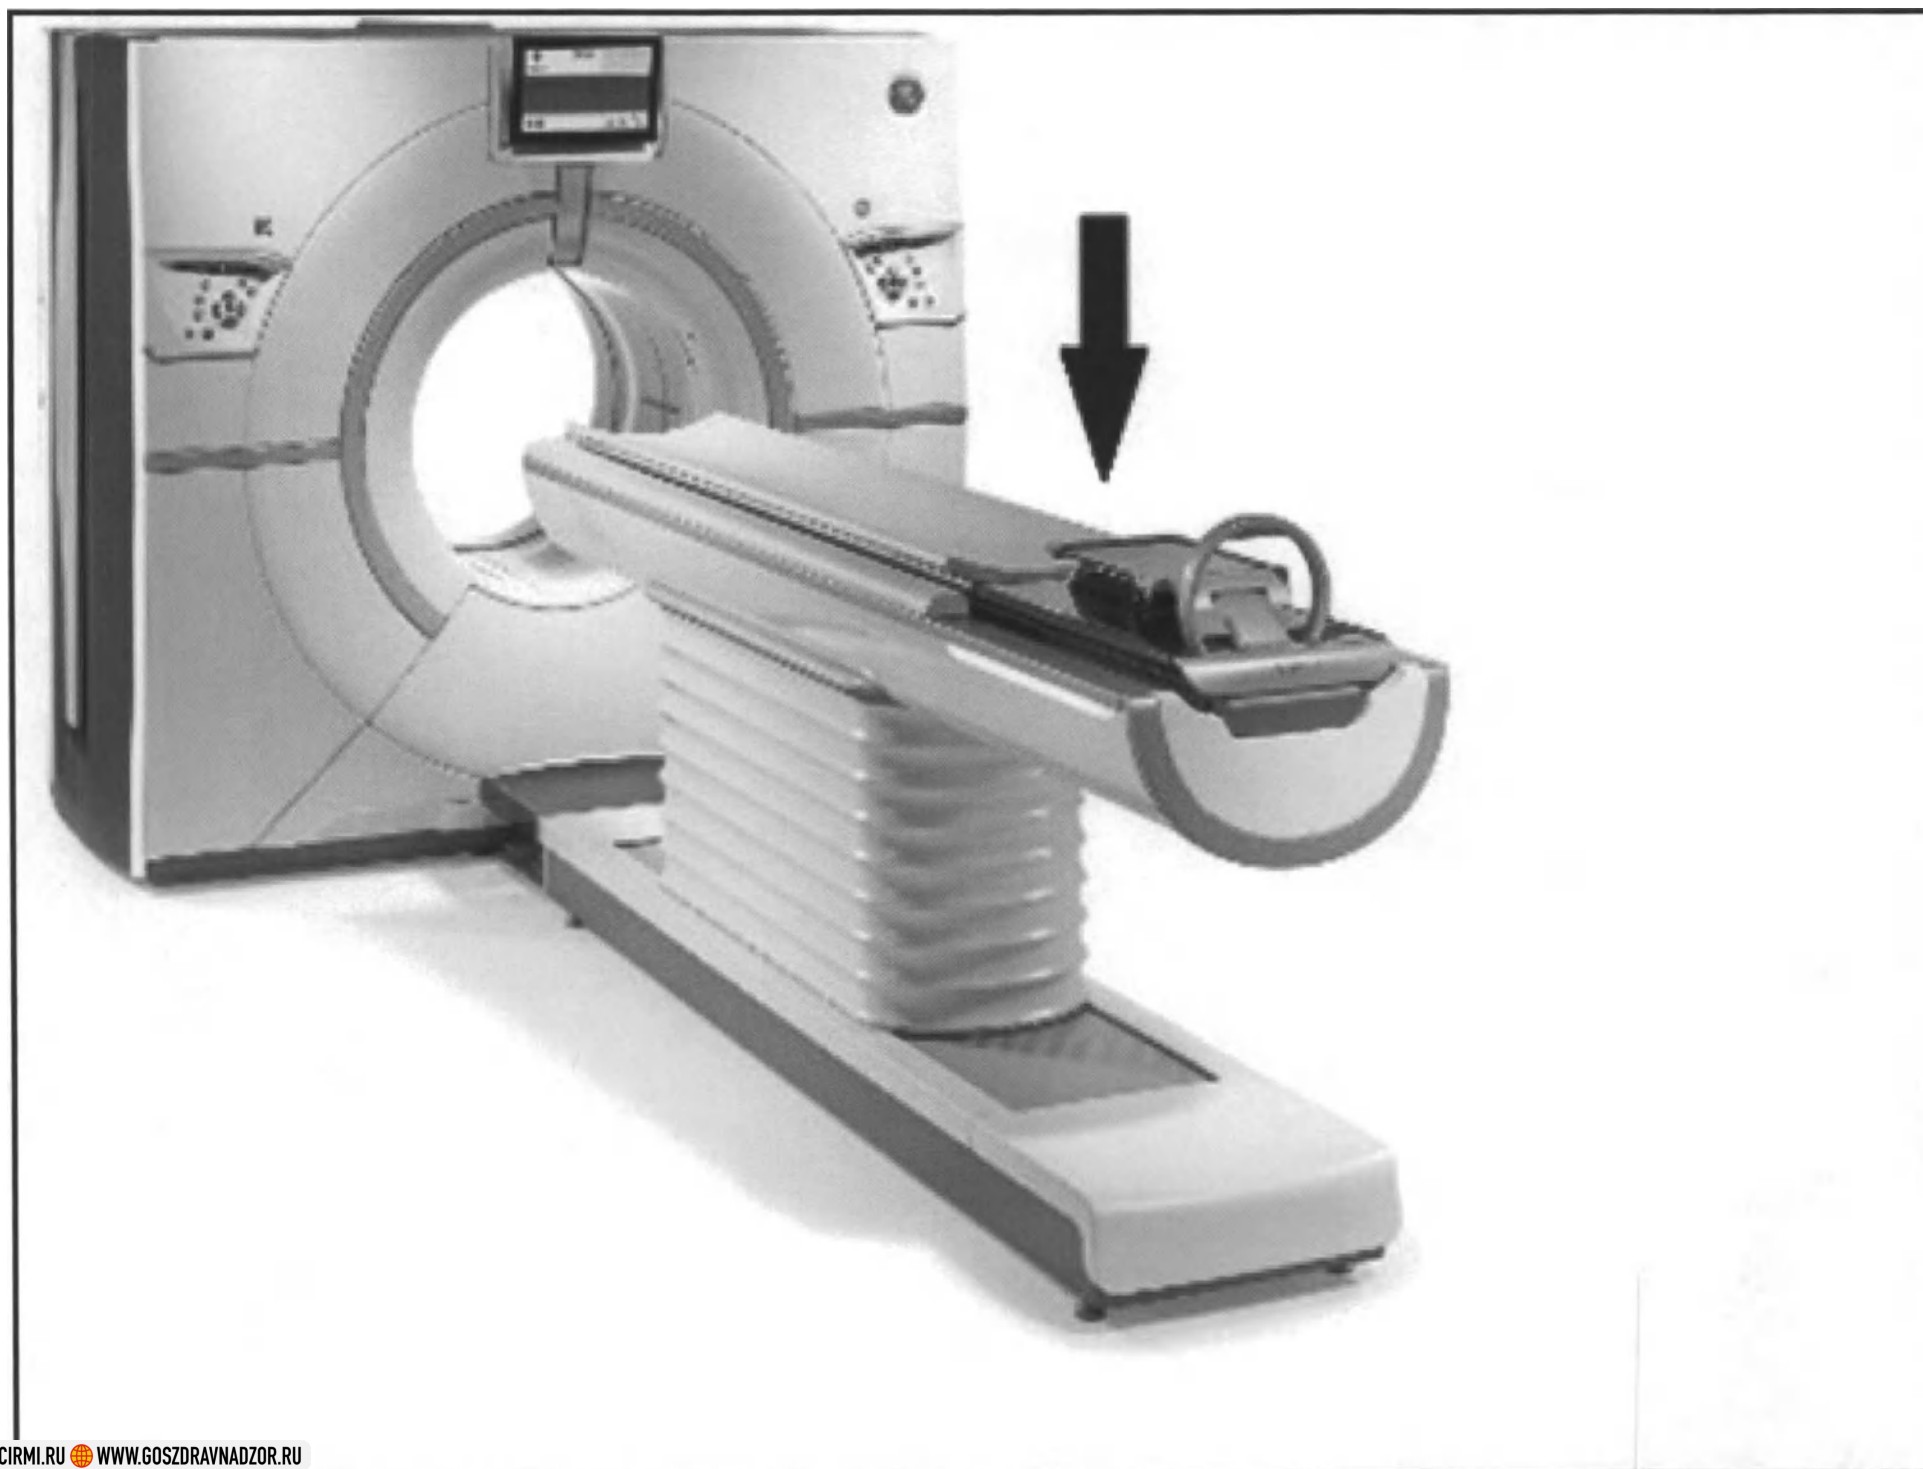

14. Защитные крышки стола пациента (не более 20 шт.).

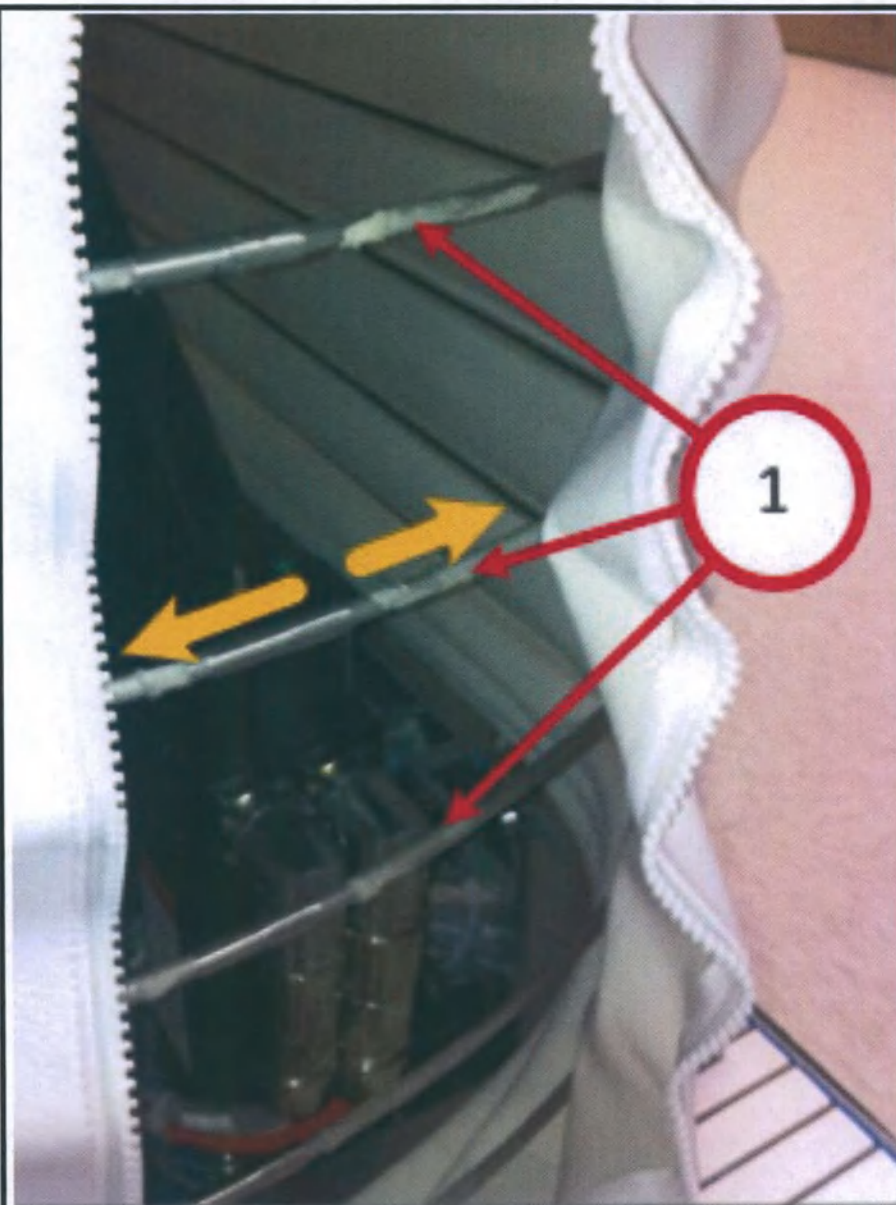

15. Устройство транспортировочное для крышек гентри (не более 5 шт.).



16. Блок реконструкции (не более 5 шт.).




17. Блоки кардиологического мониторинга и синхронизации (не более 5 шт.).



17. Блоки кардиологического мониторинга и синхронизации (не более 5 шт.).



16. программное обеспечение для интервенционных процедур на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях——(не более 10 шт.).

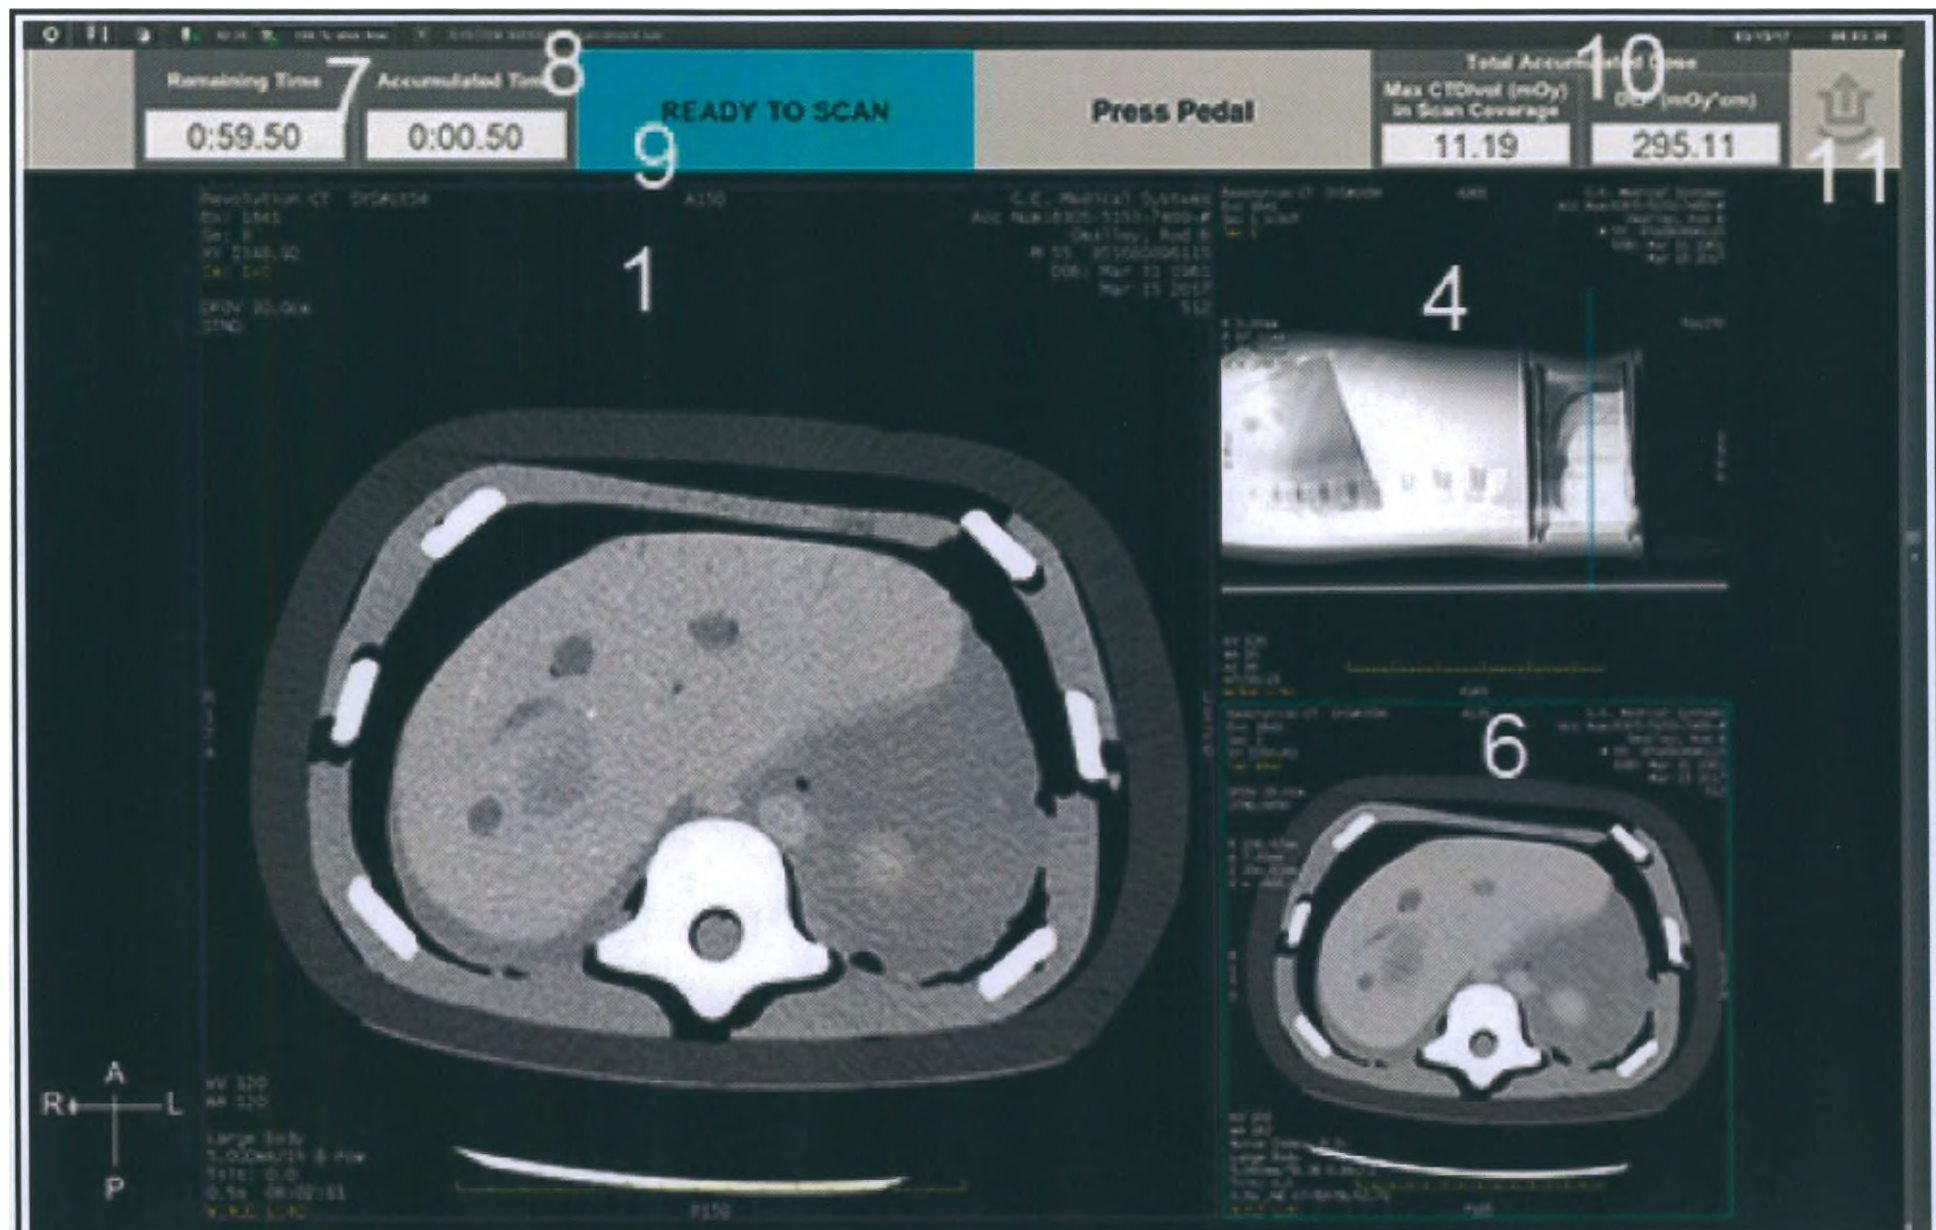


Schedule


" HIS/RIS Search Applied "

Name	Patient ID	Accession #	Exam	Date	Patients
Patterson, Dale	555-802-796				Patterson, Dale
Lungman, Earl	111-222-333-444				Langman, Earl
Lee, Margaret	653-009-677				Lee, Margaret
Gail, Al	12345				Gail, Al
					05:33 AM IV
					03:09 PM N


SELECT PATIENT

20. Программный пакет сбора данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

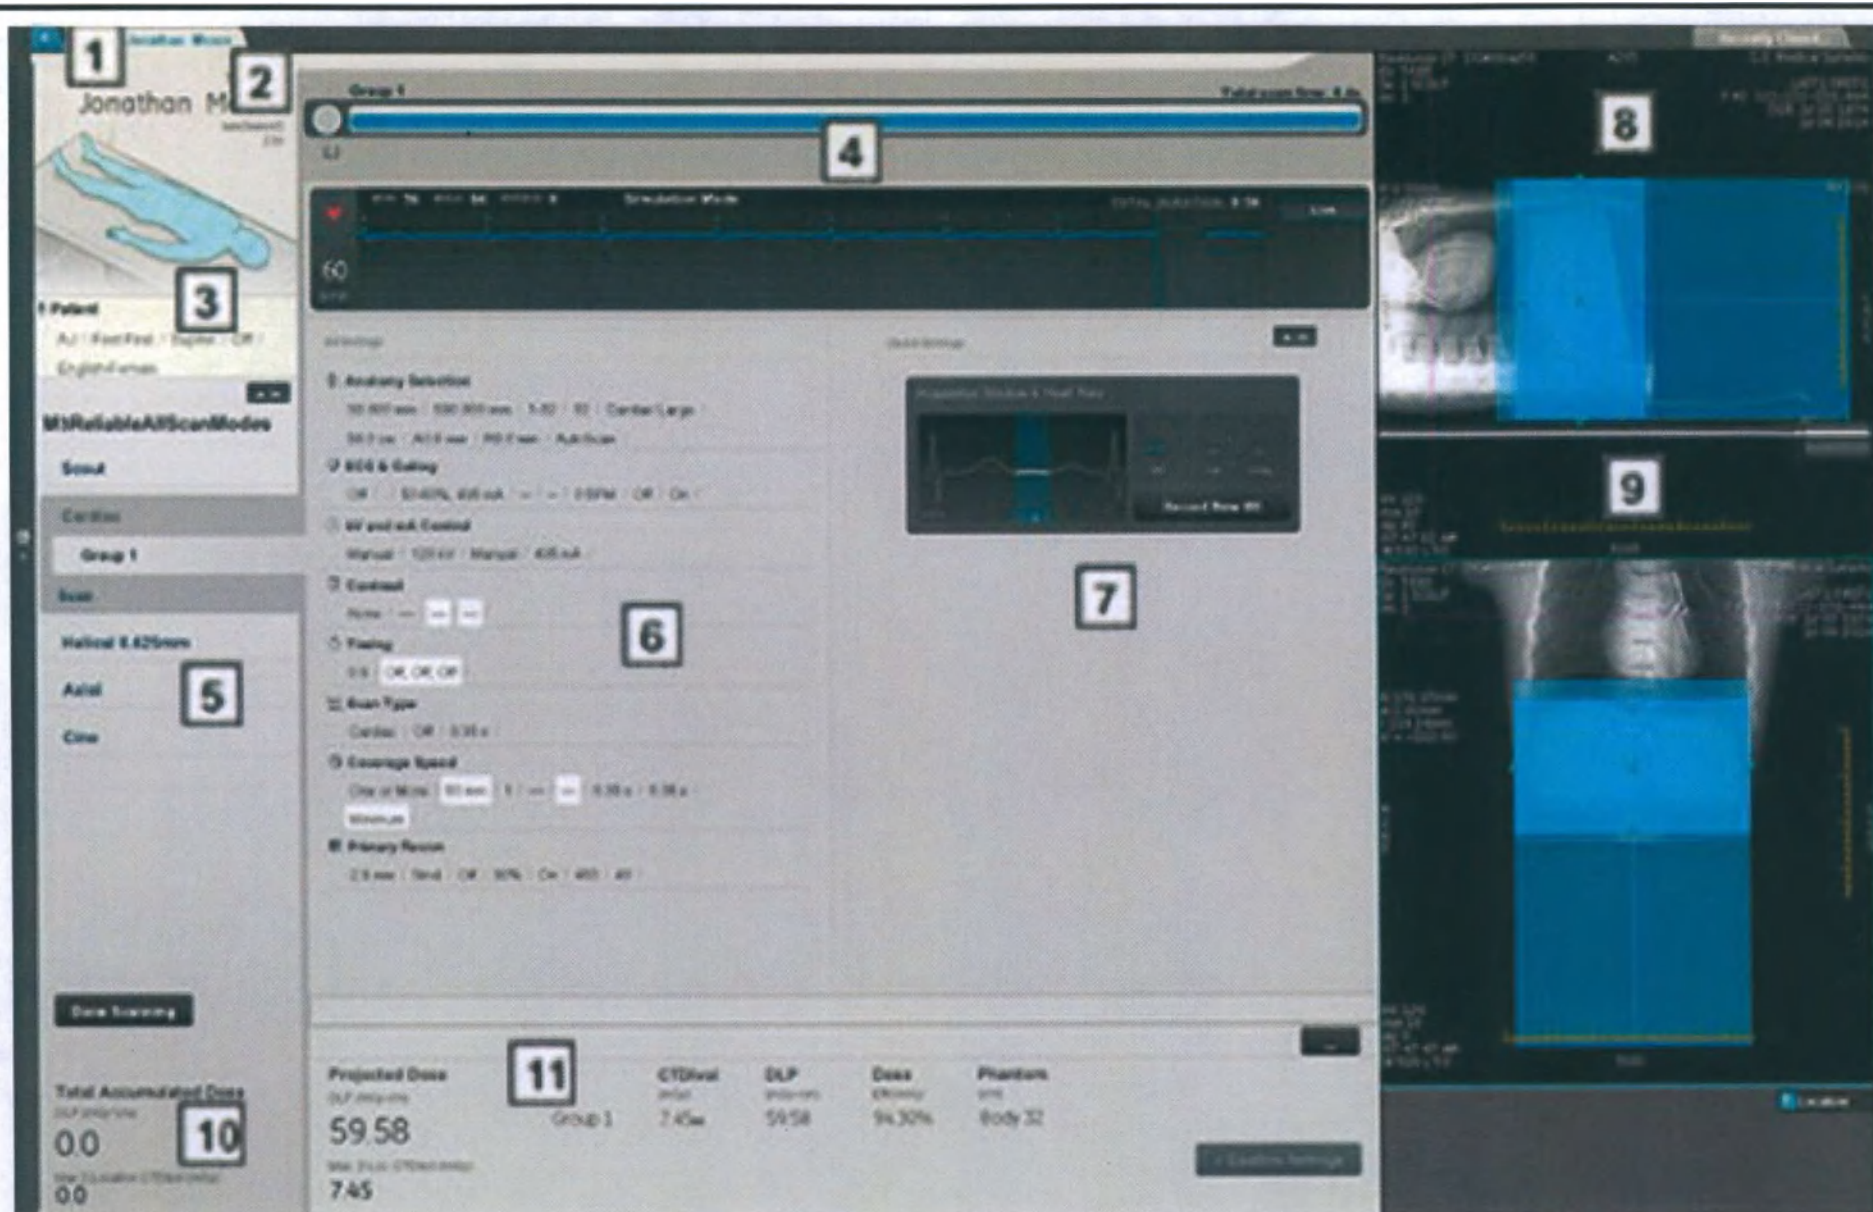


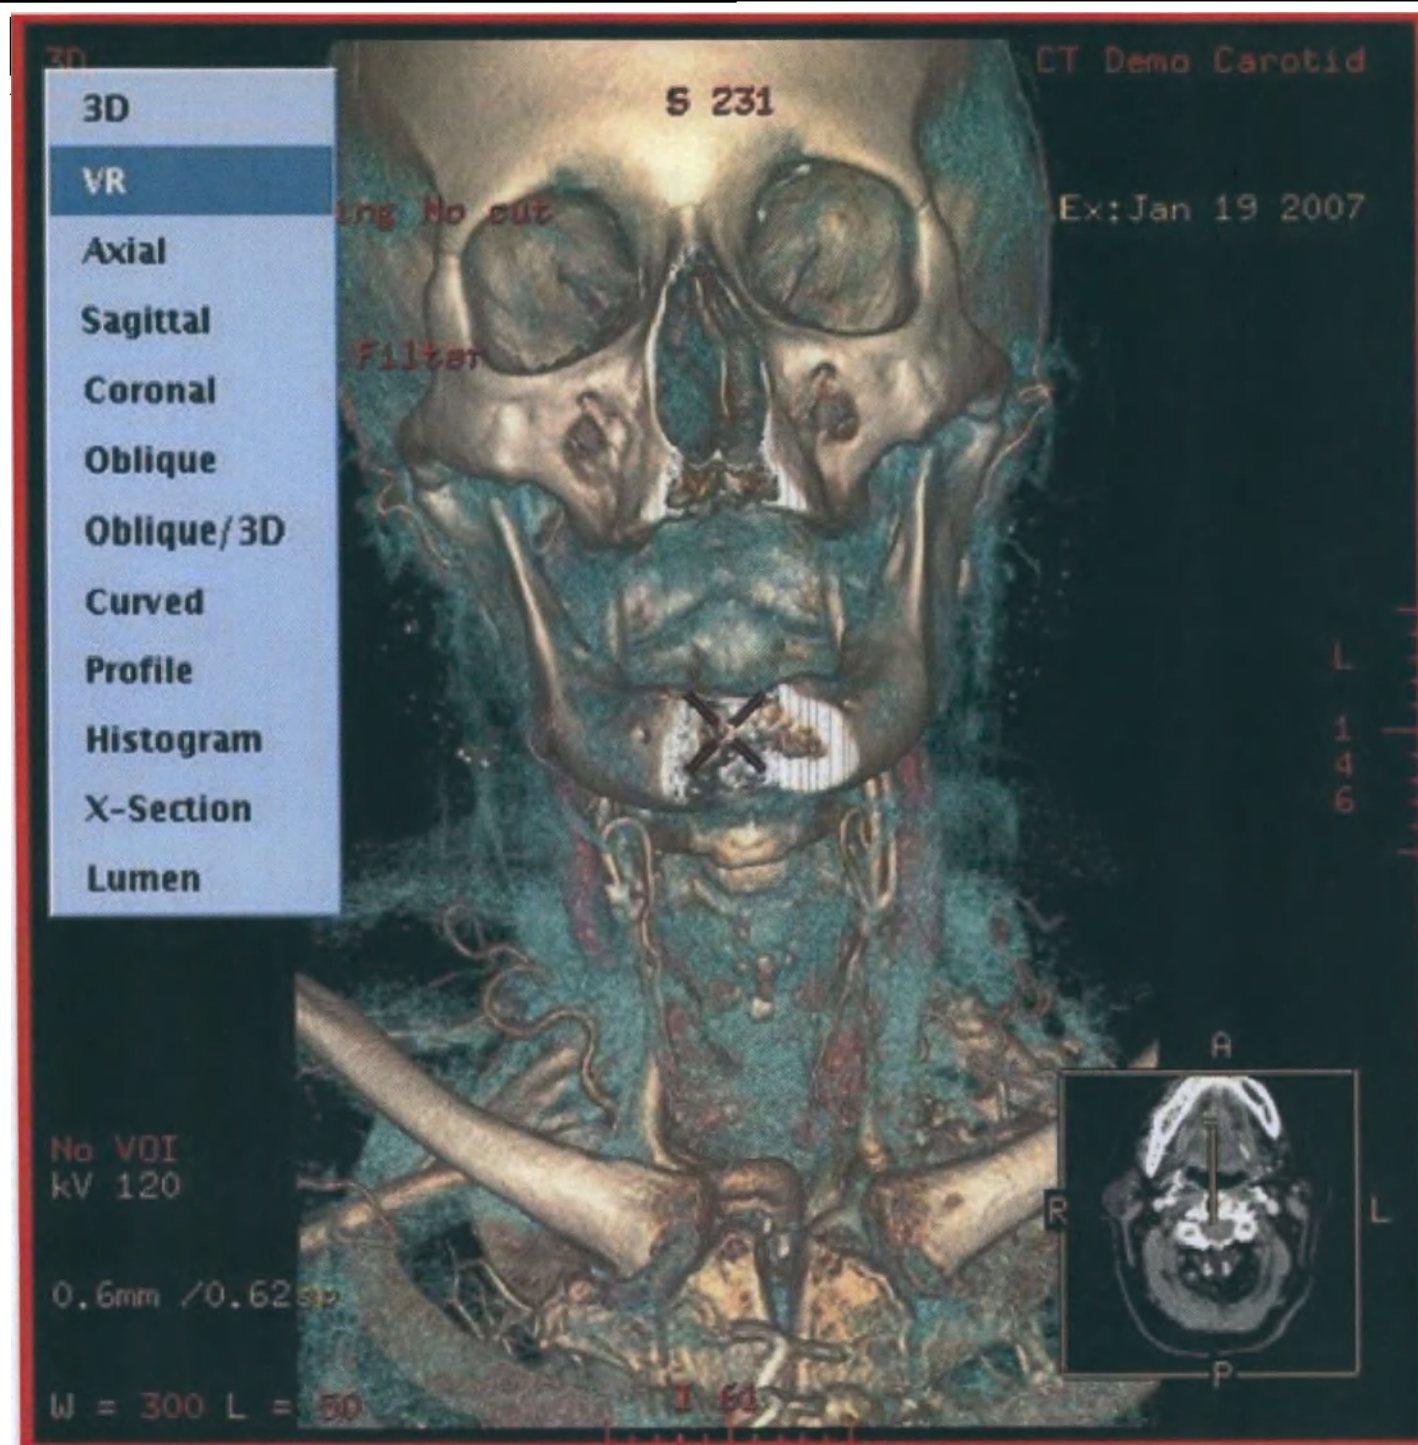


22. Программный пакет двумерной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).

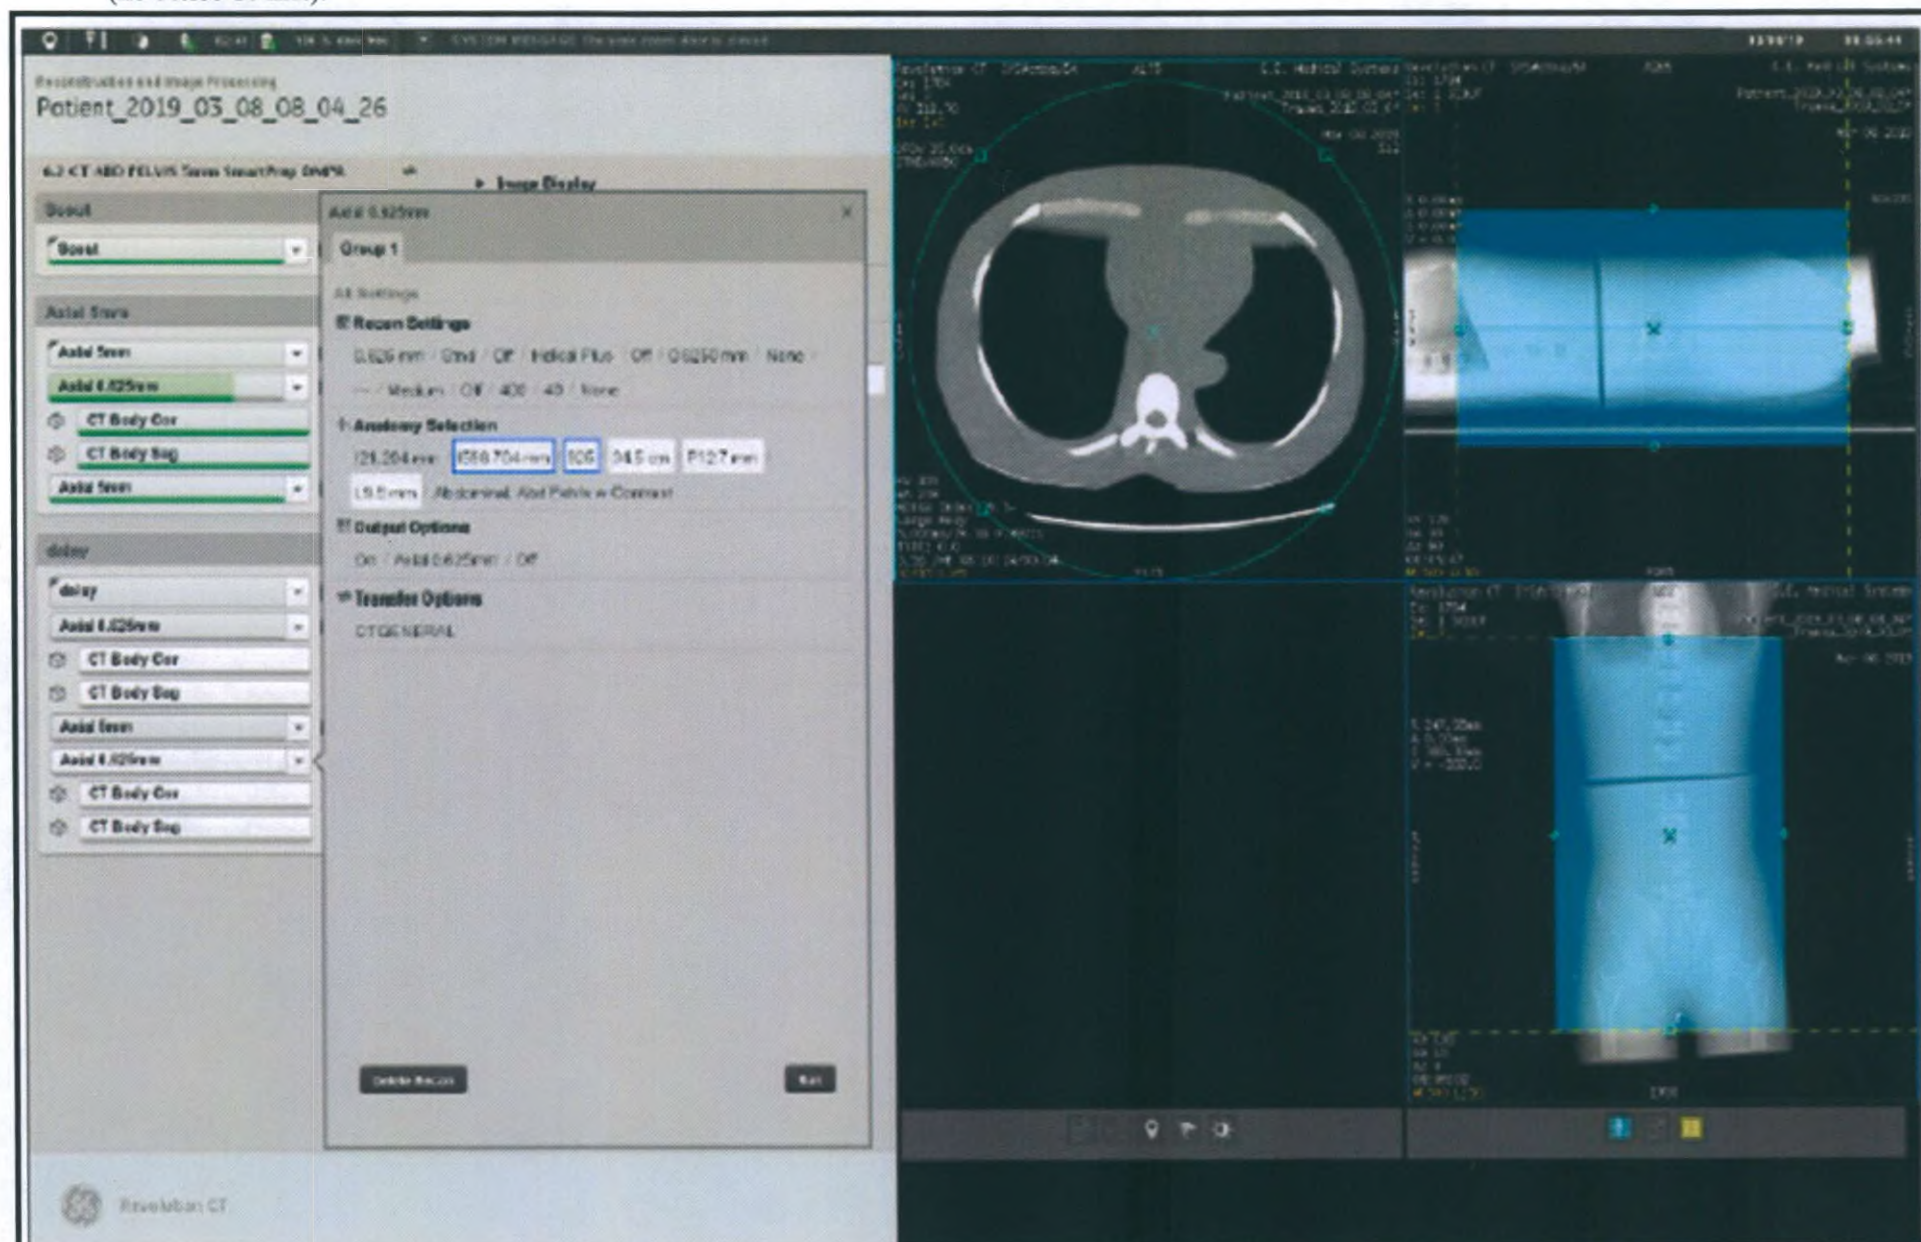


23. Программный пакет трехмерной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

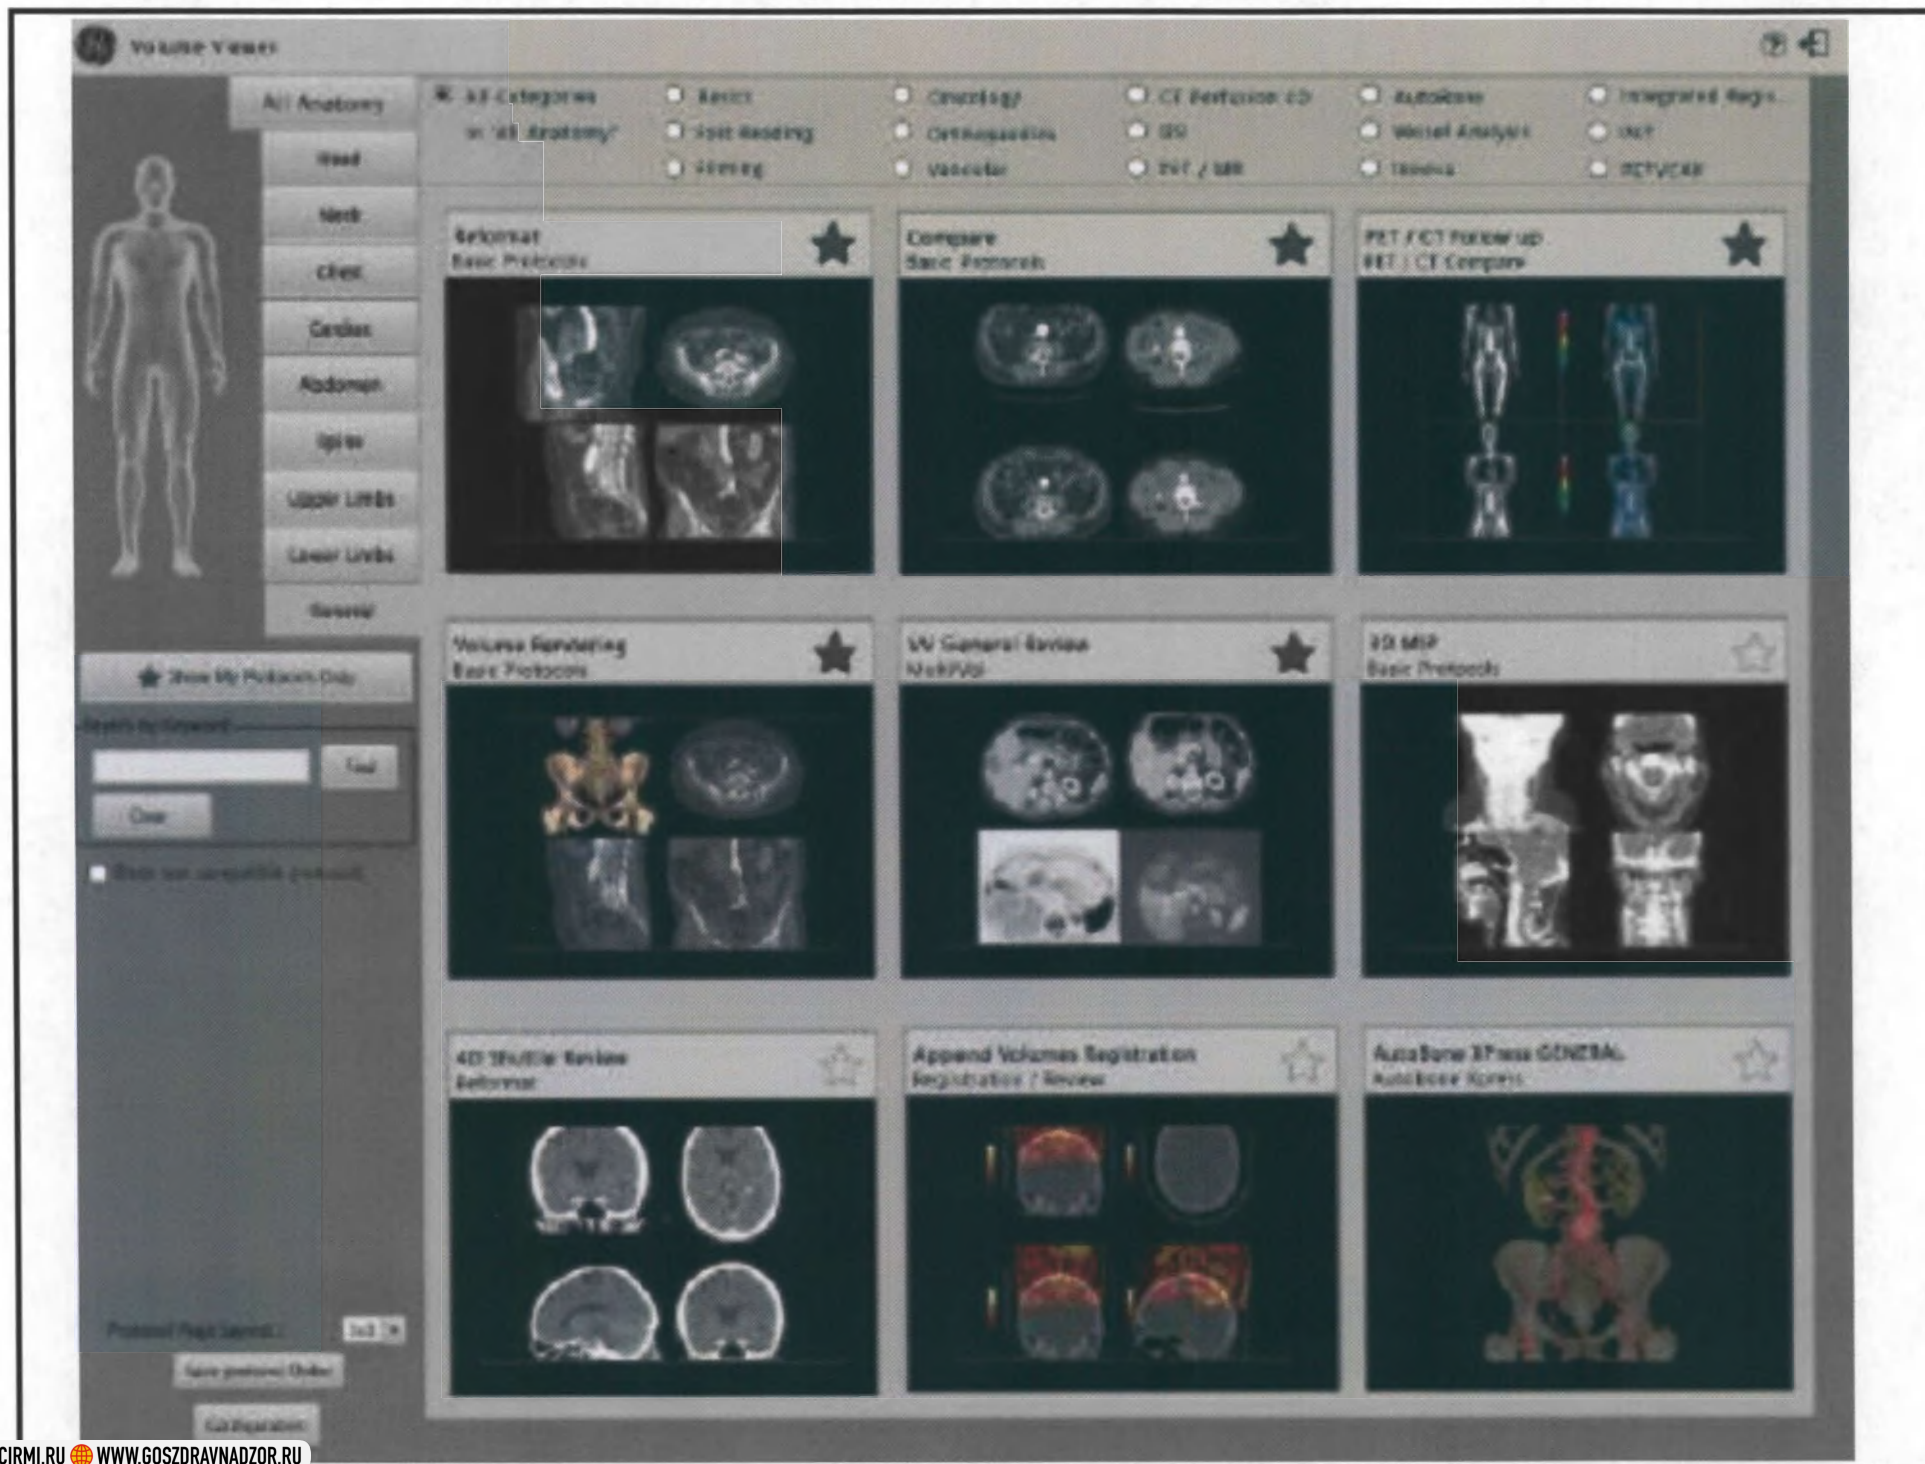




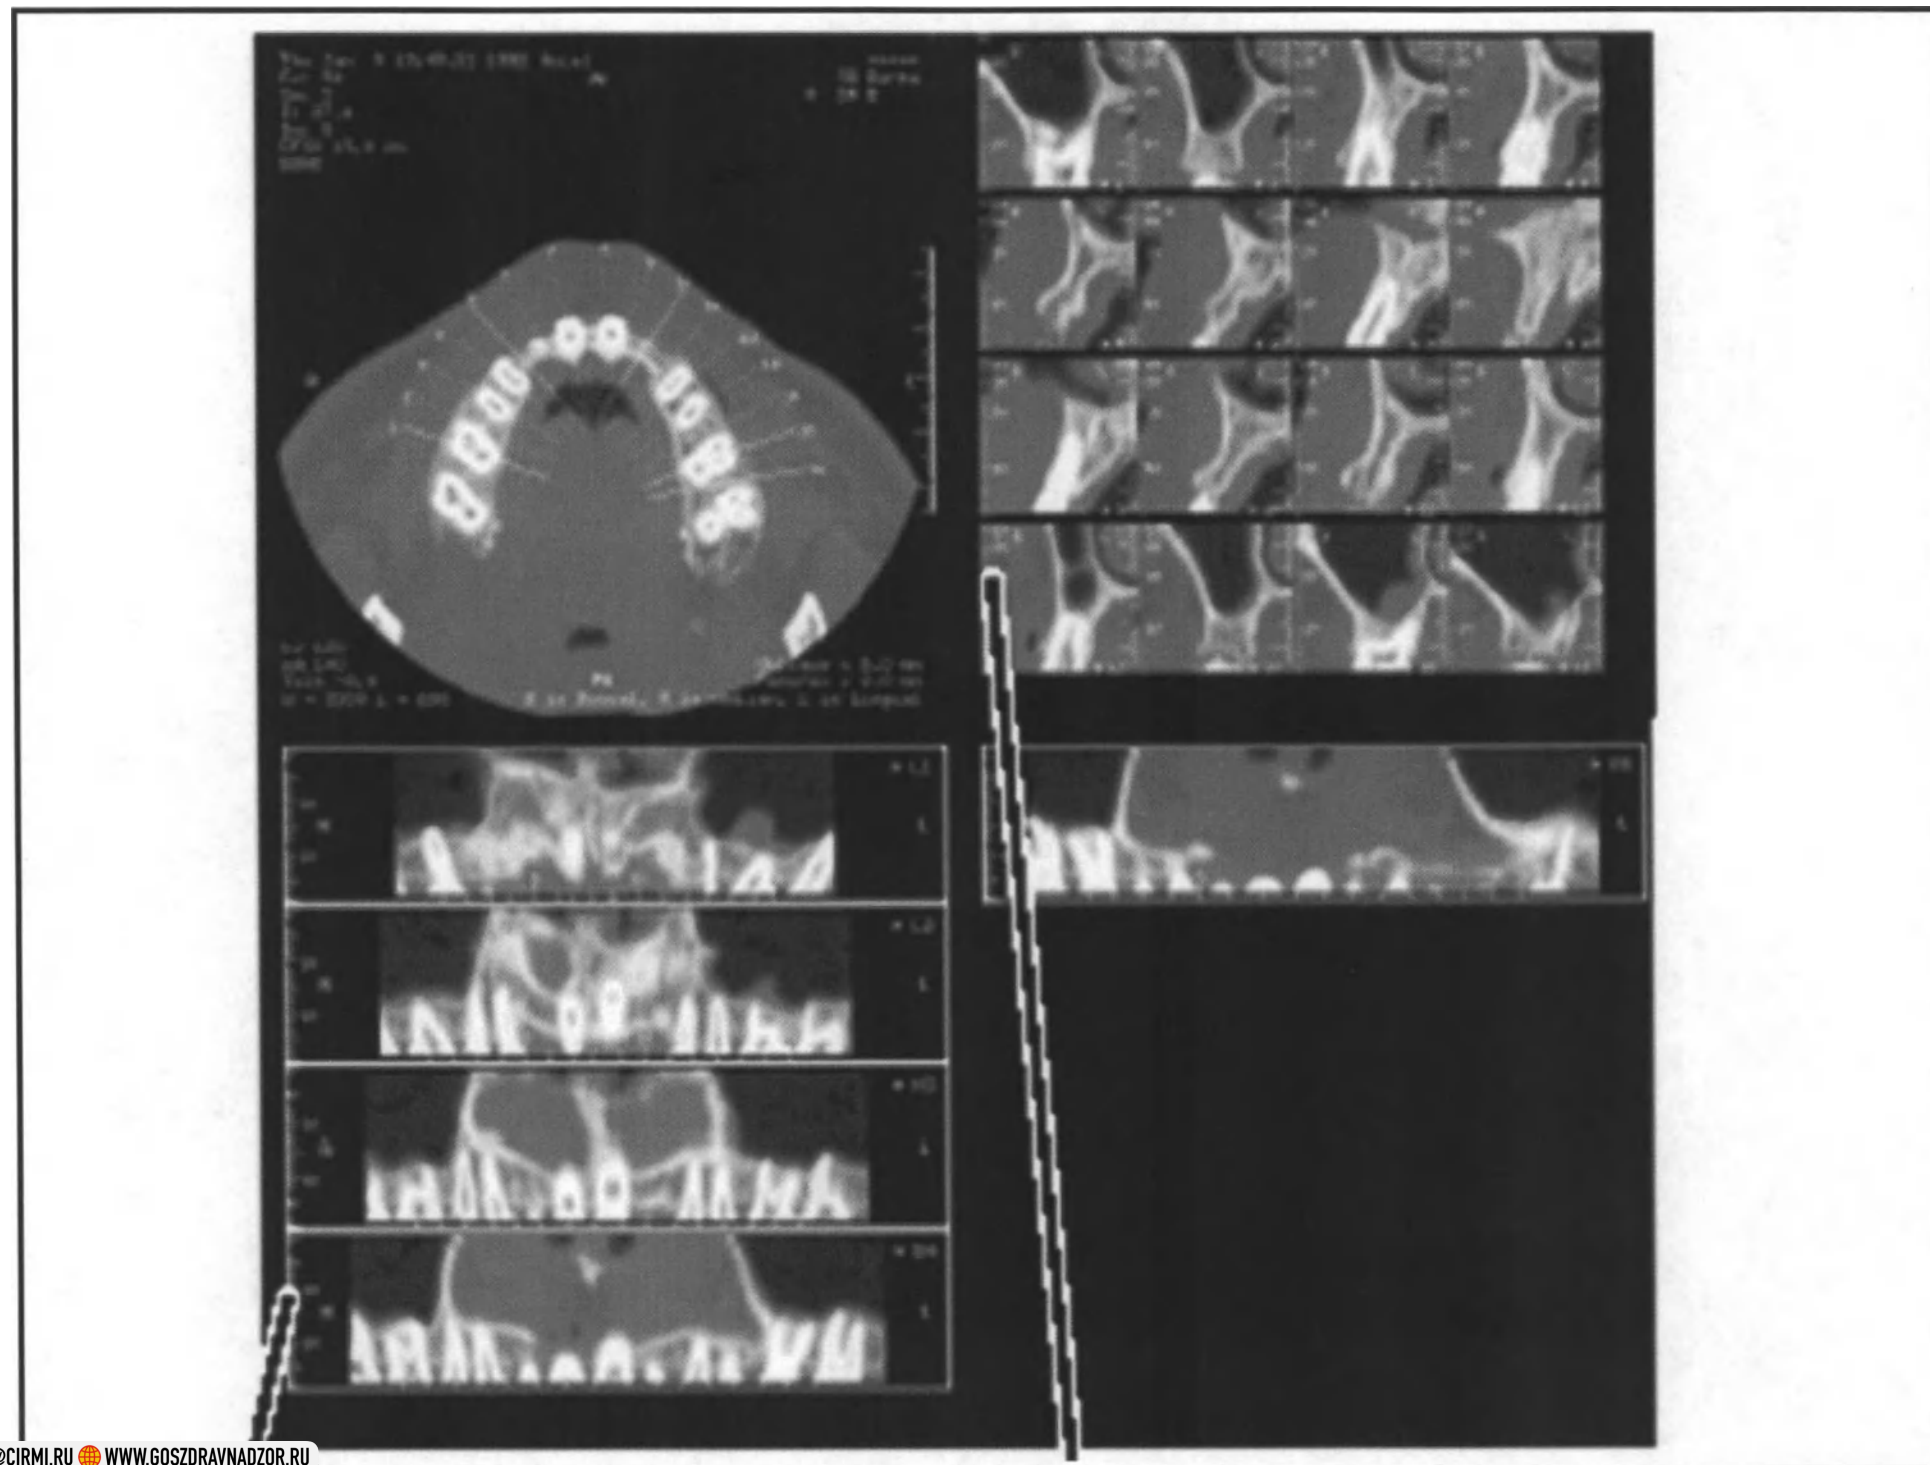


26. Программный пакет для легочной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).

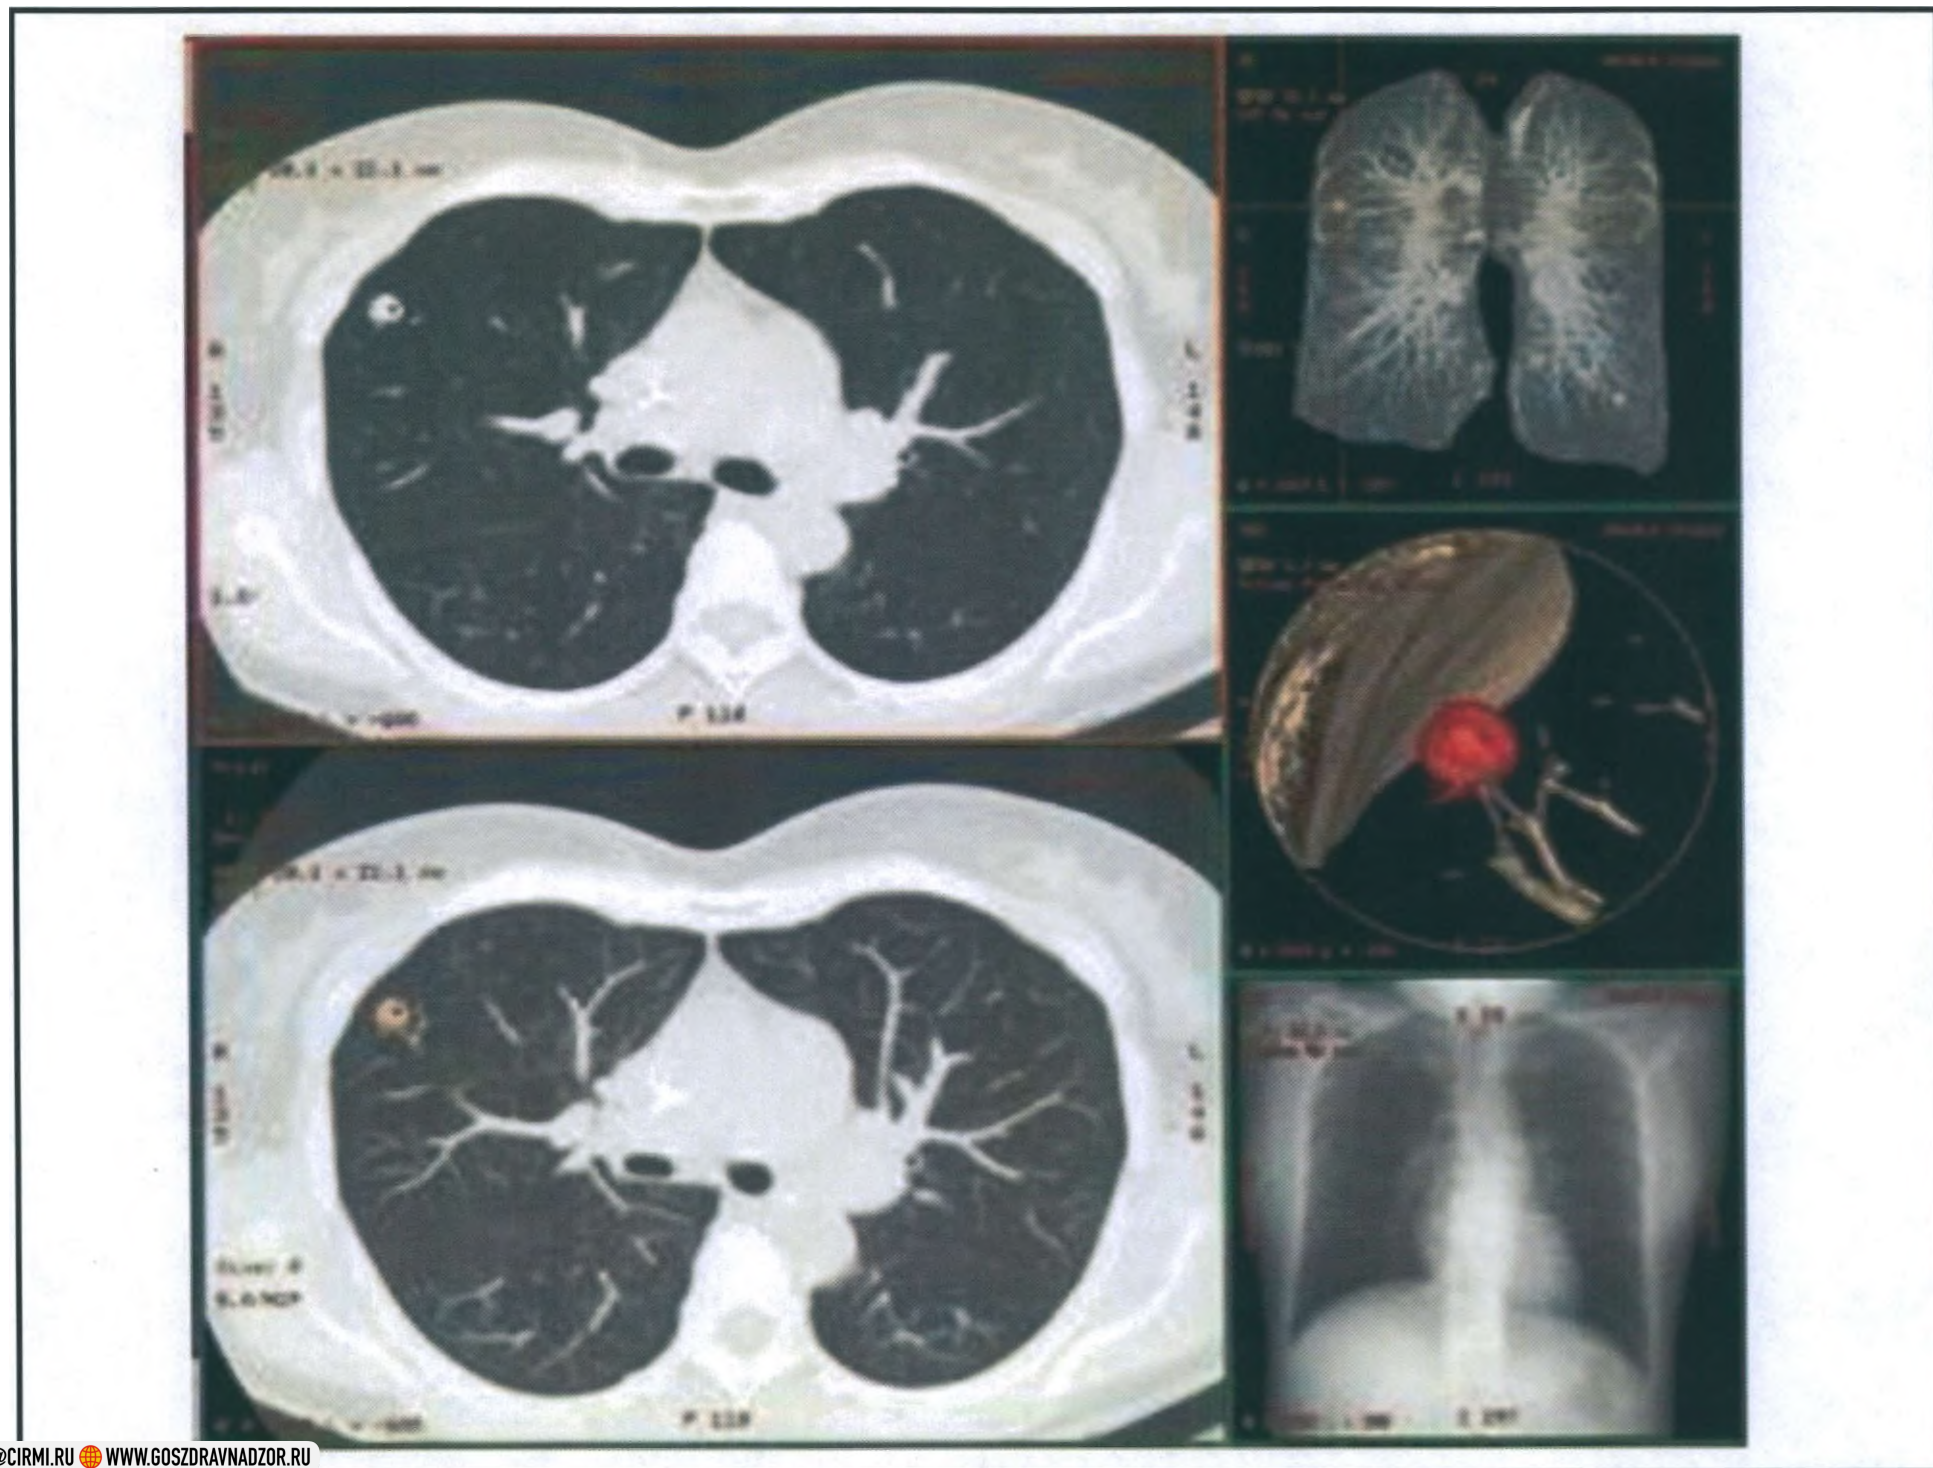


27. Программный пакет для кишечной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

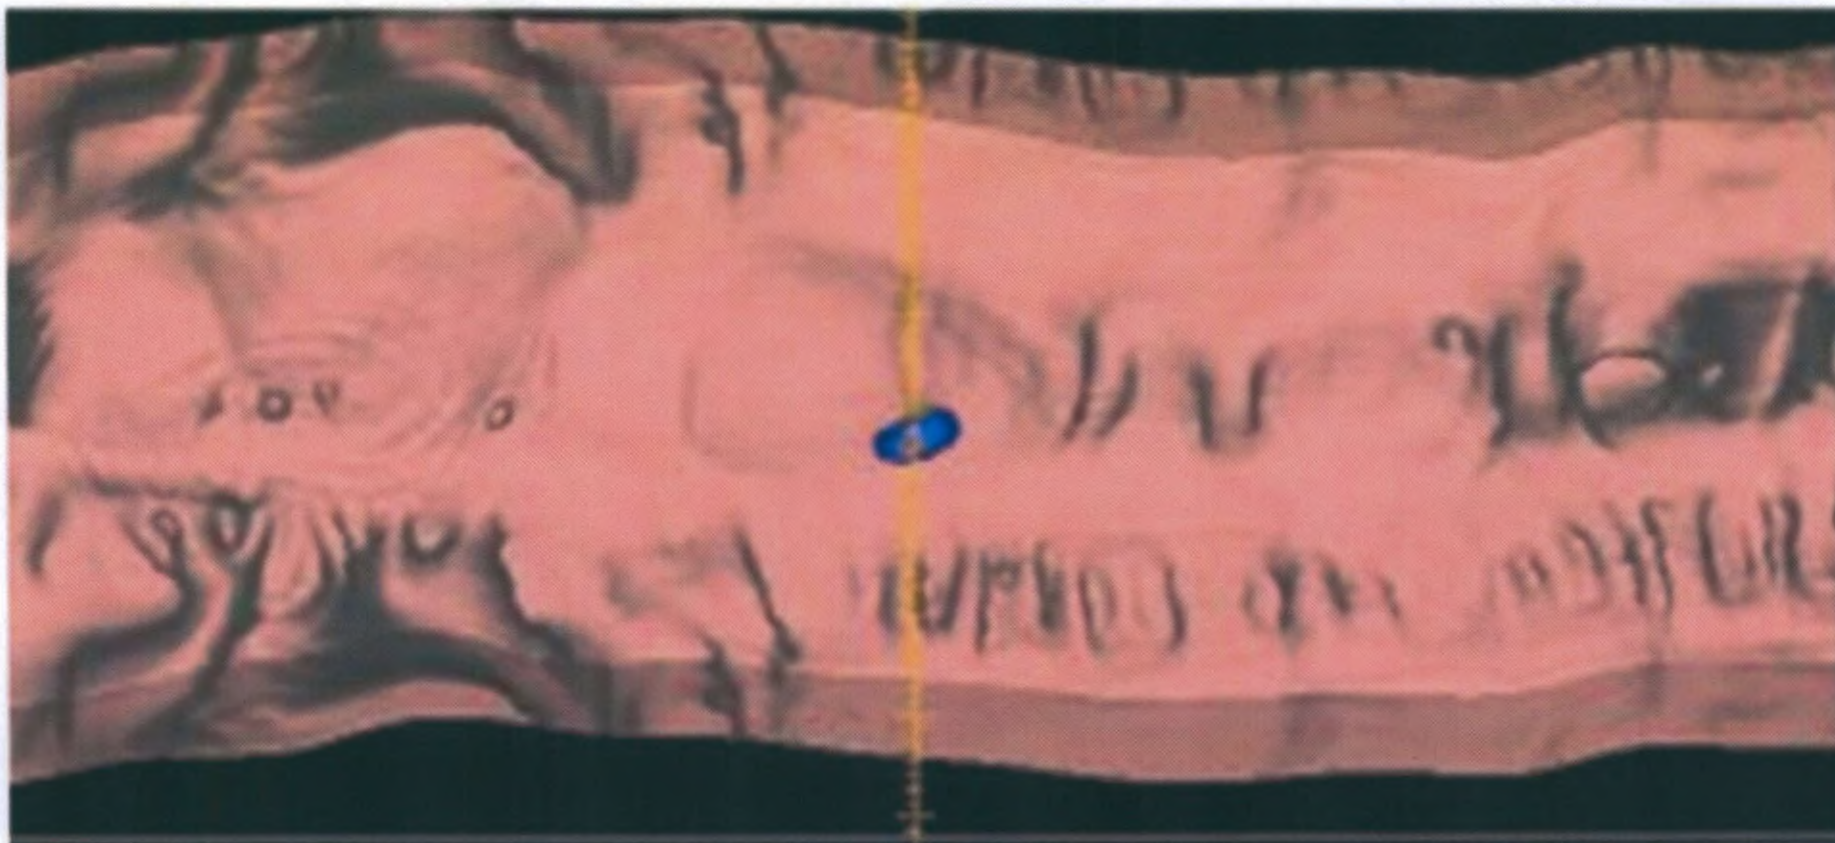


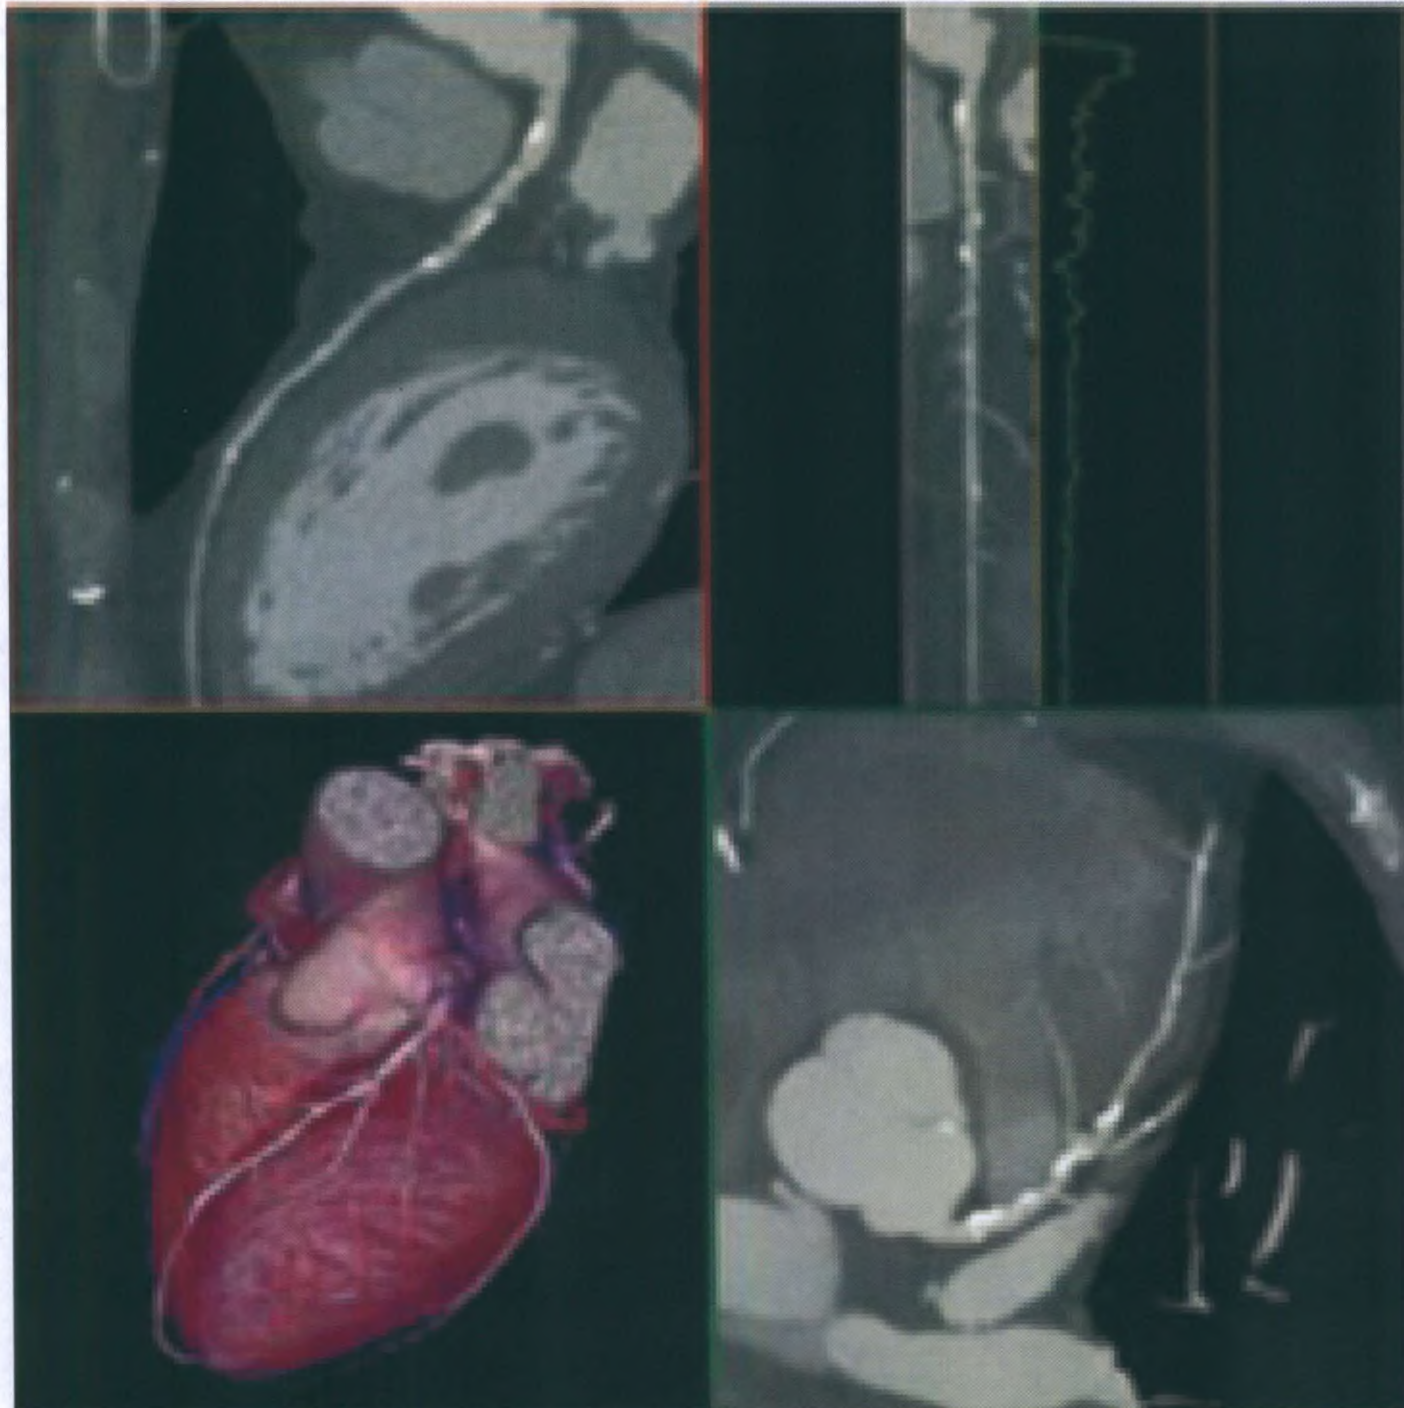


29. Программный пакет для перфузионного расчета на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).

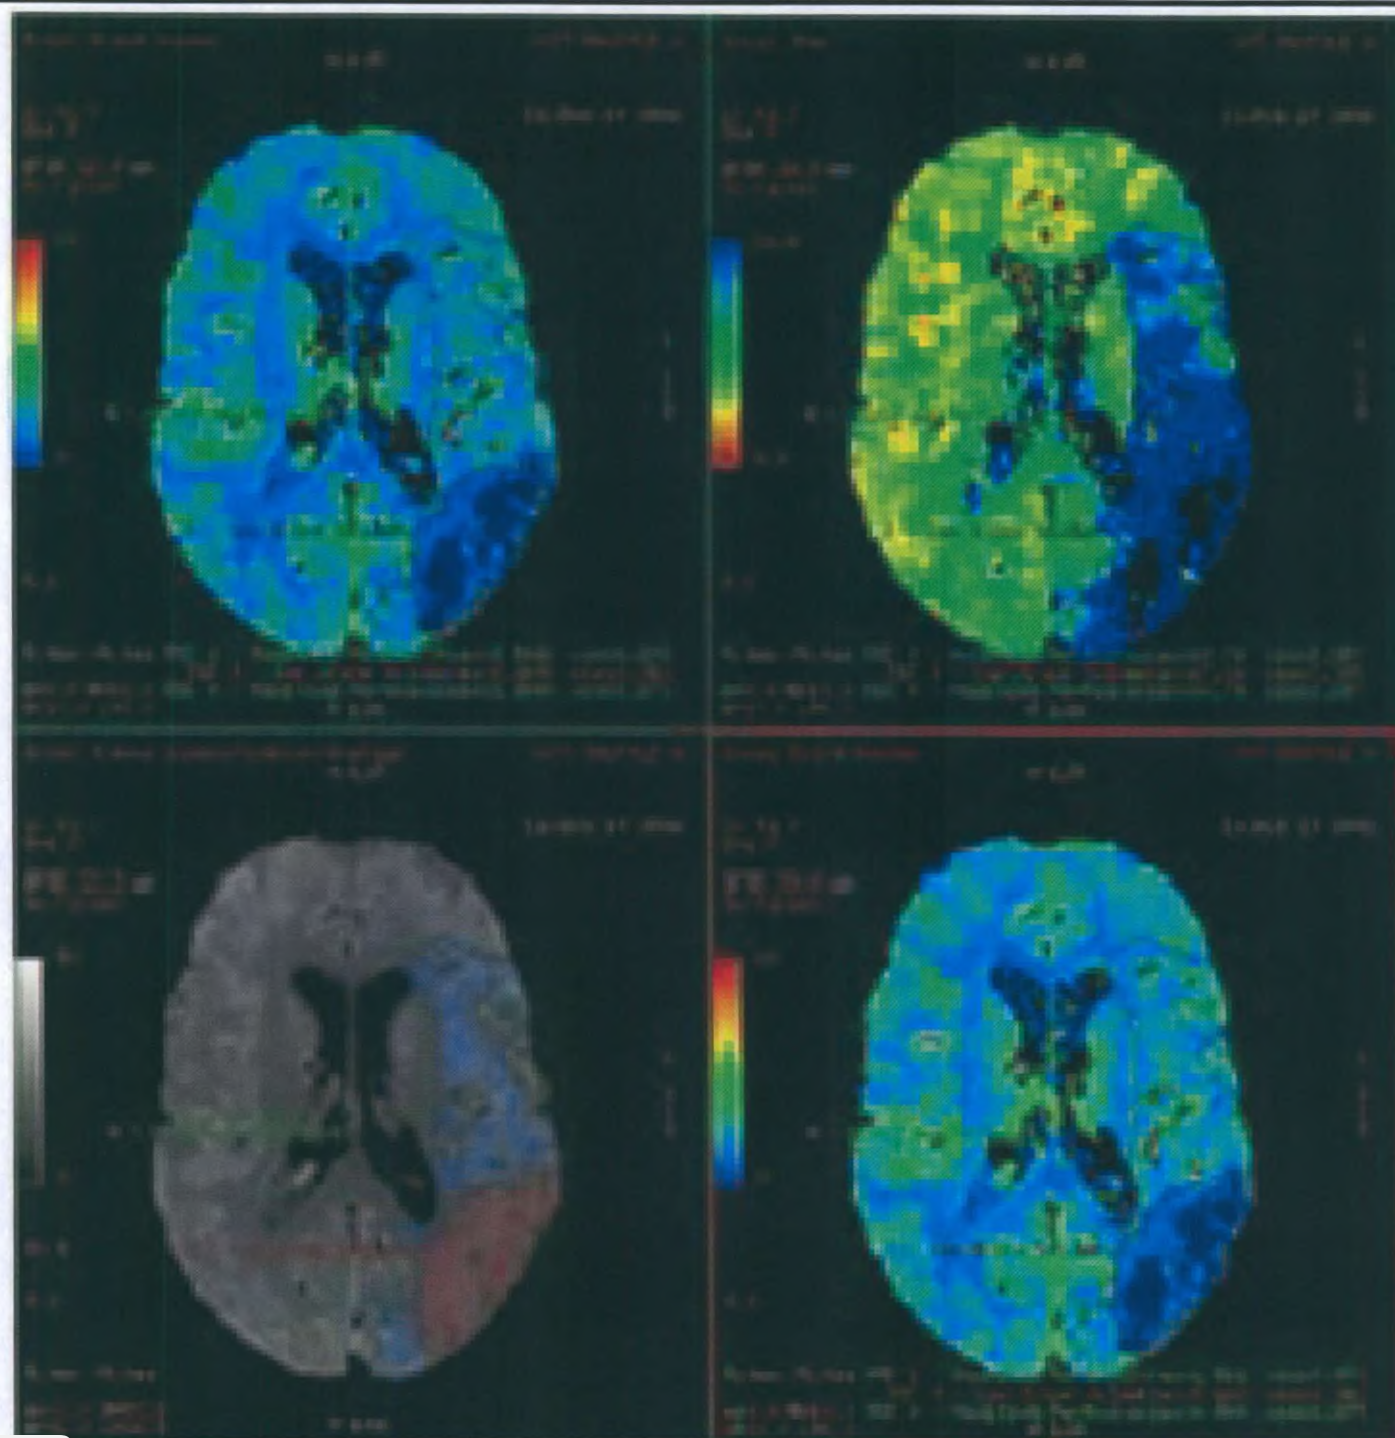

30. Программный пакет расчета костной плотности на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 5 шт.).

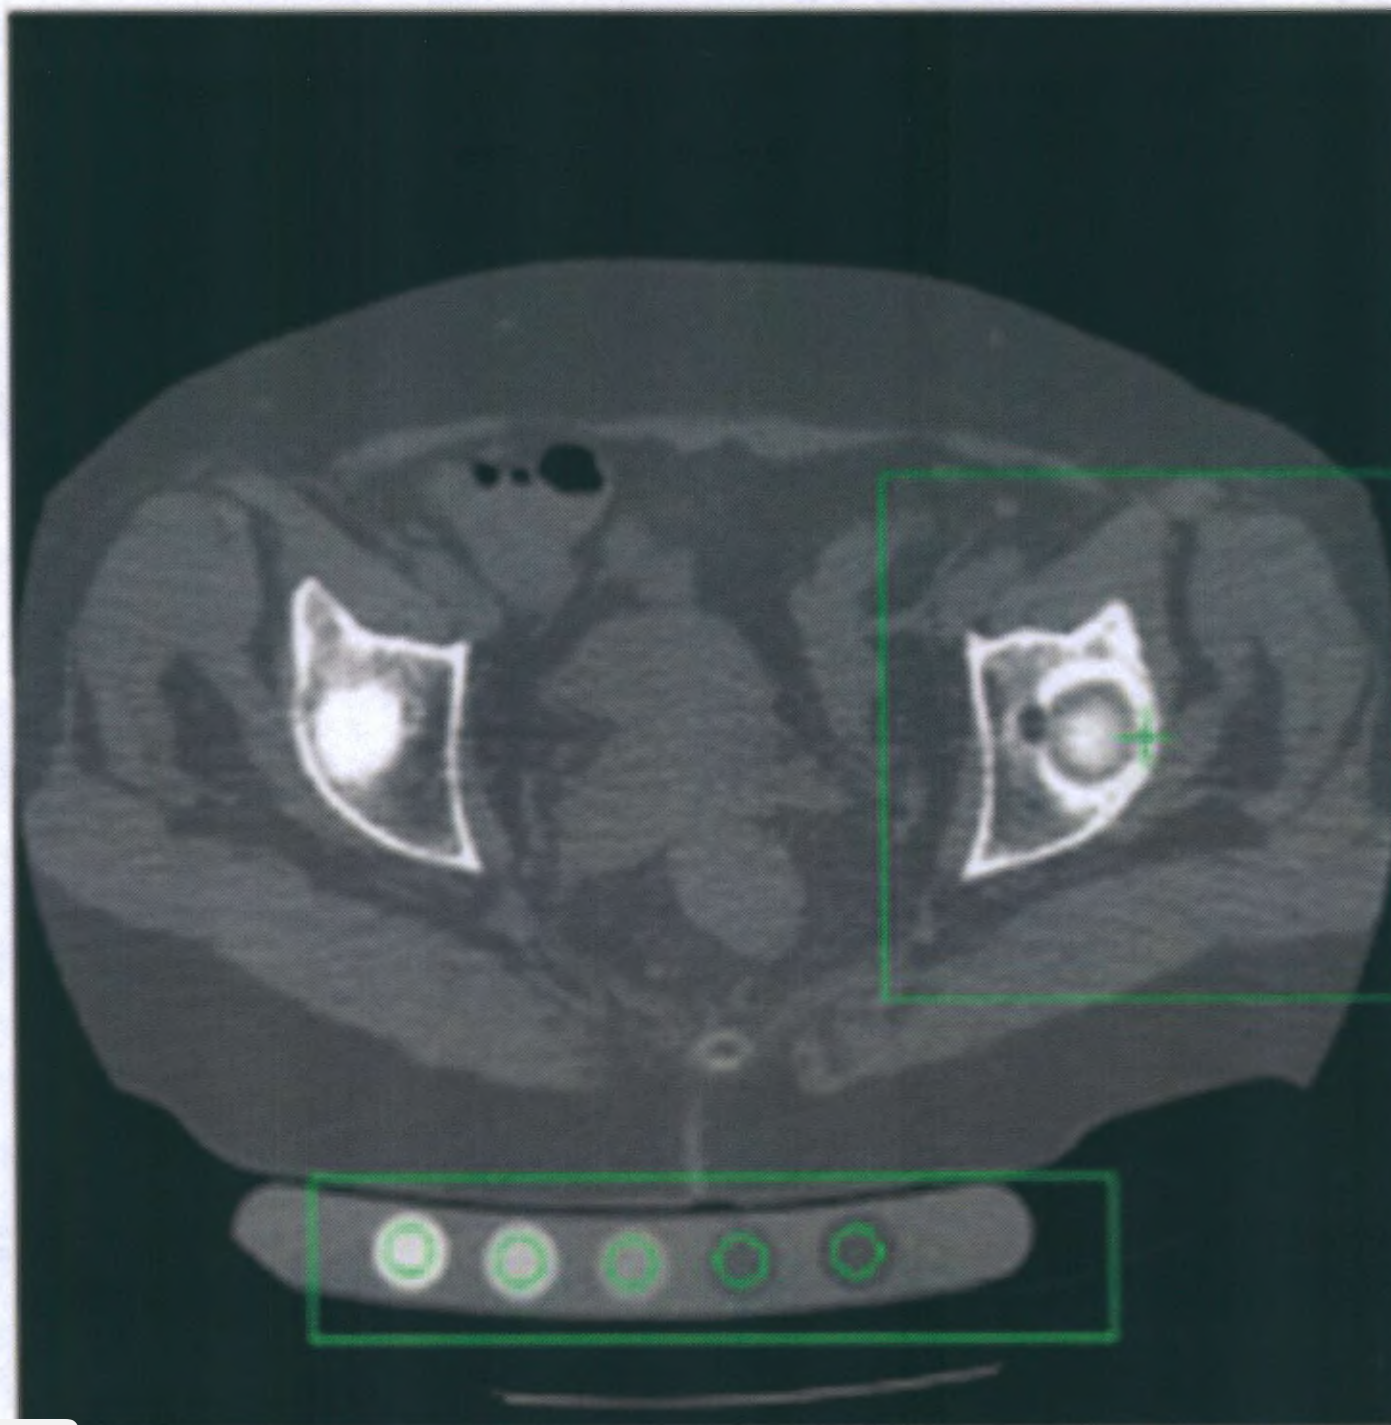

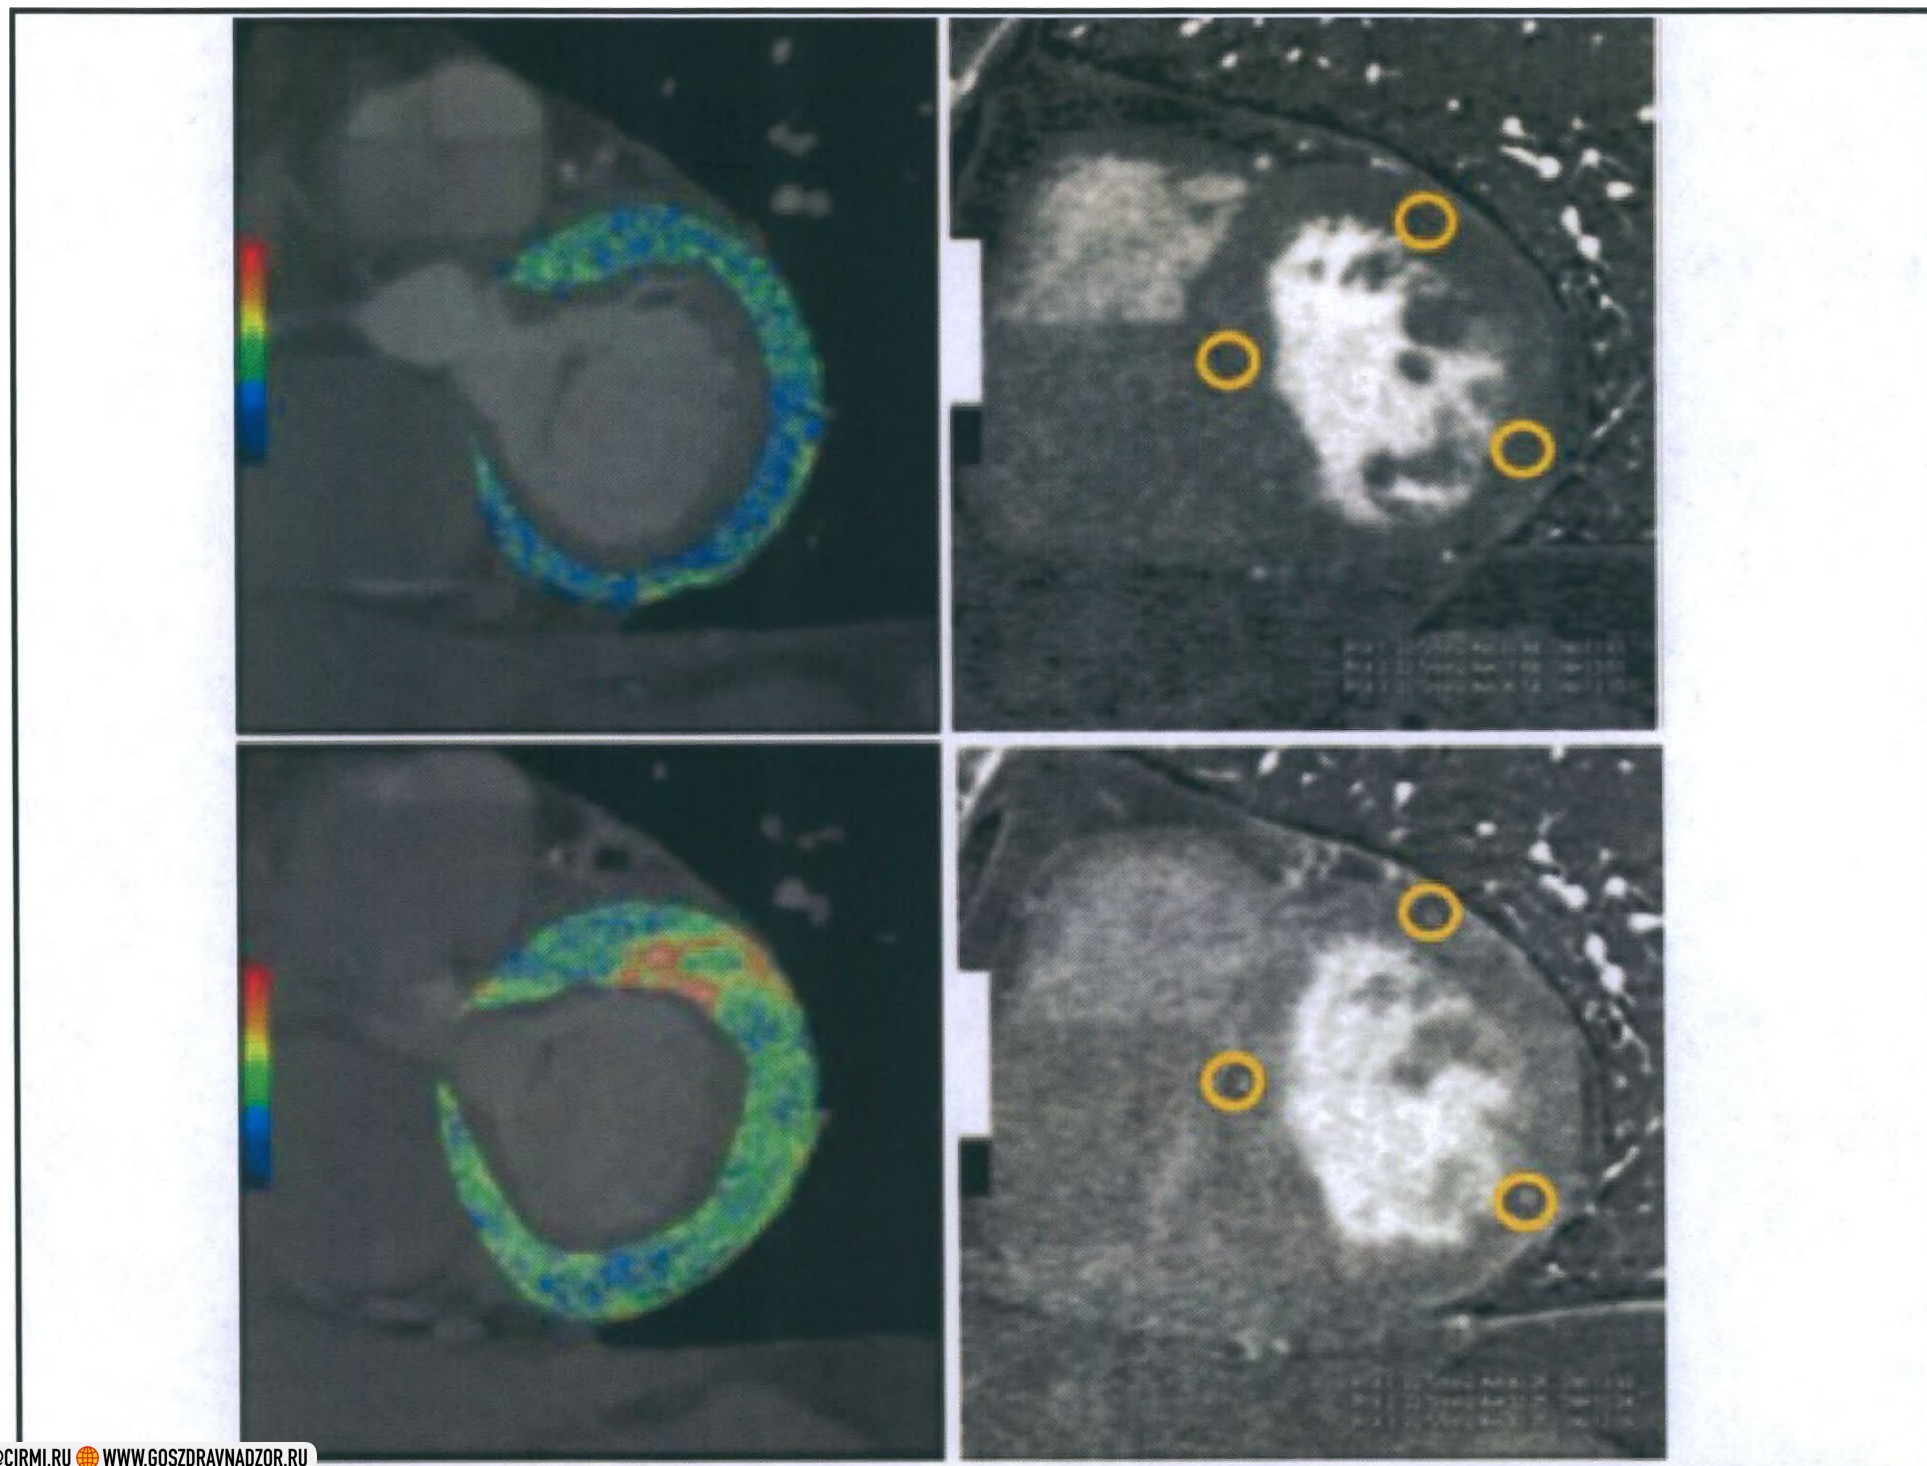

Ⓐ **kV and mA Control**

kV Mode

☐ **GSI**

kV

80 kV - 140 kV

CID Link

Off

GSI Profile

GE Head CTA

mA Mode

☐ **GSI Assist**



mA


• **280 mA**


Noise Index

8.0


Focal Spot

• **L**

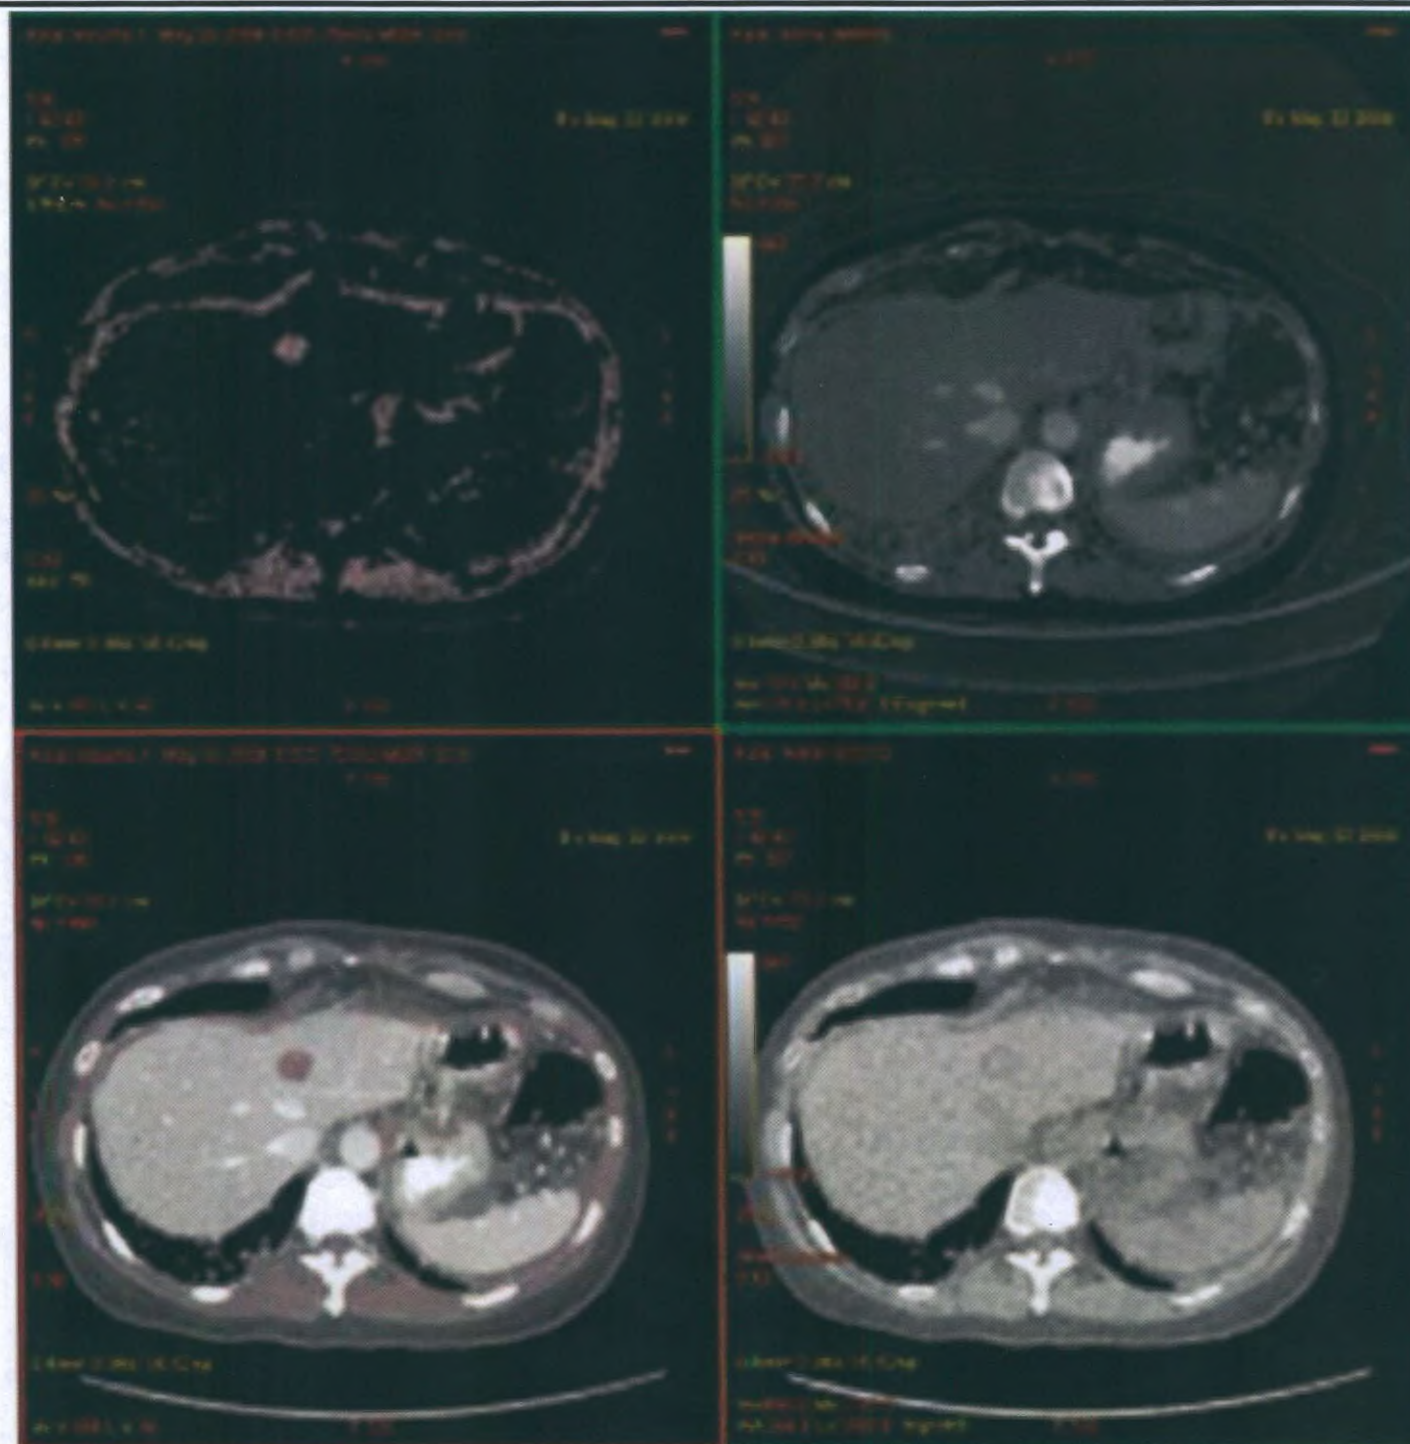

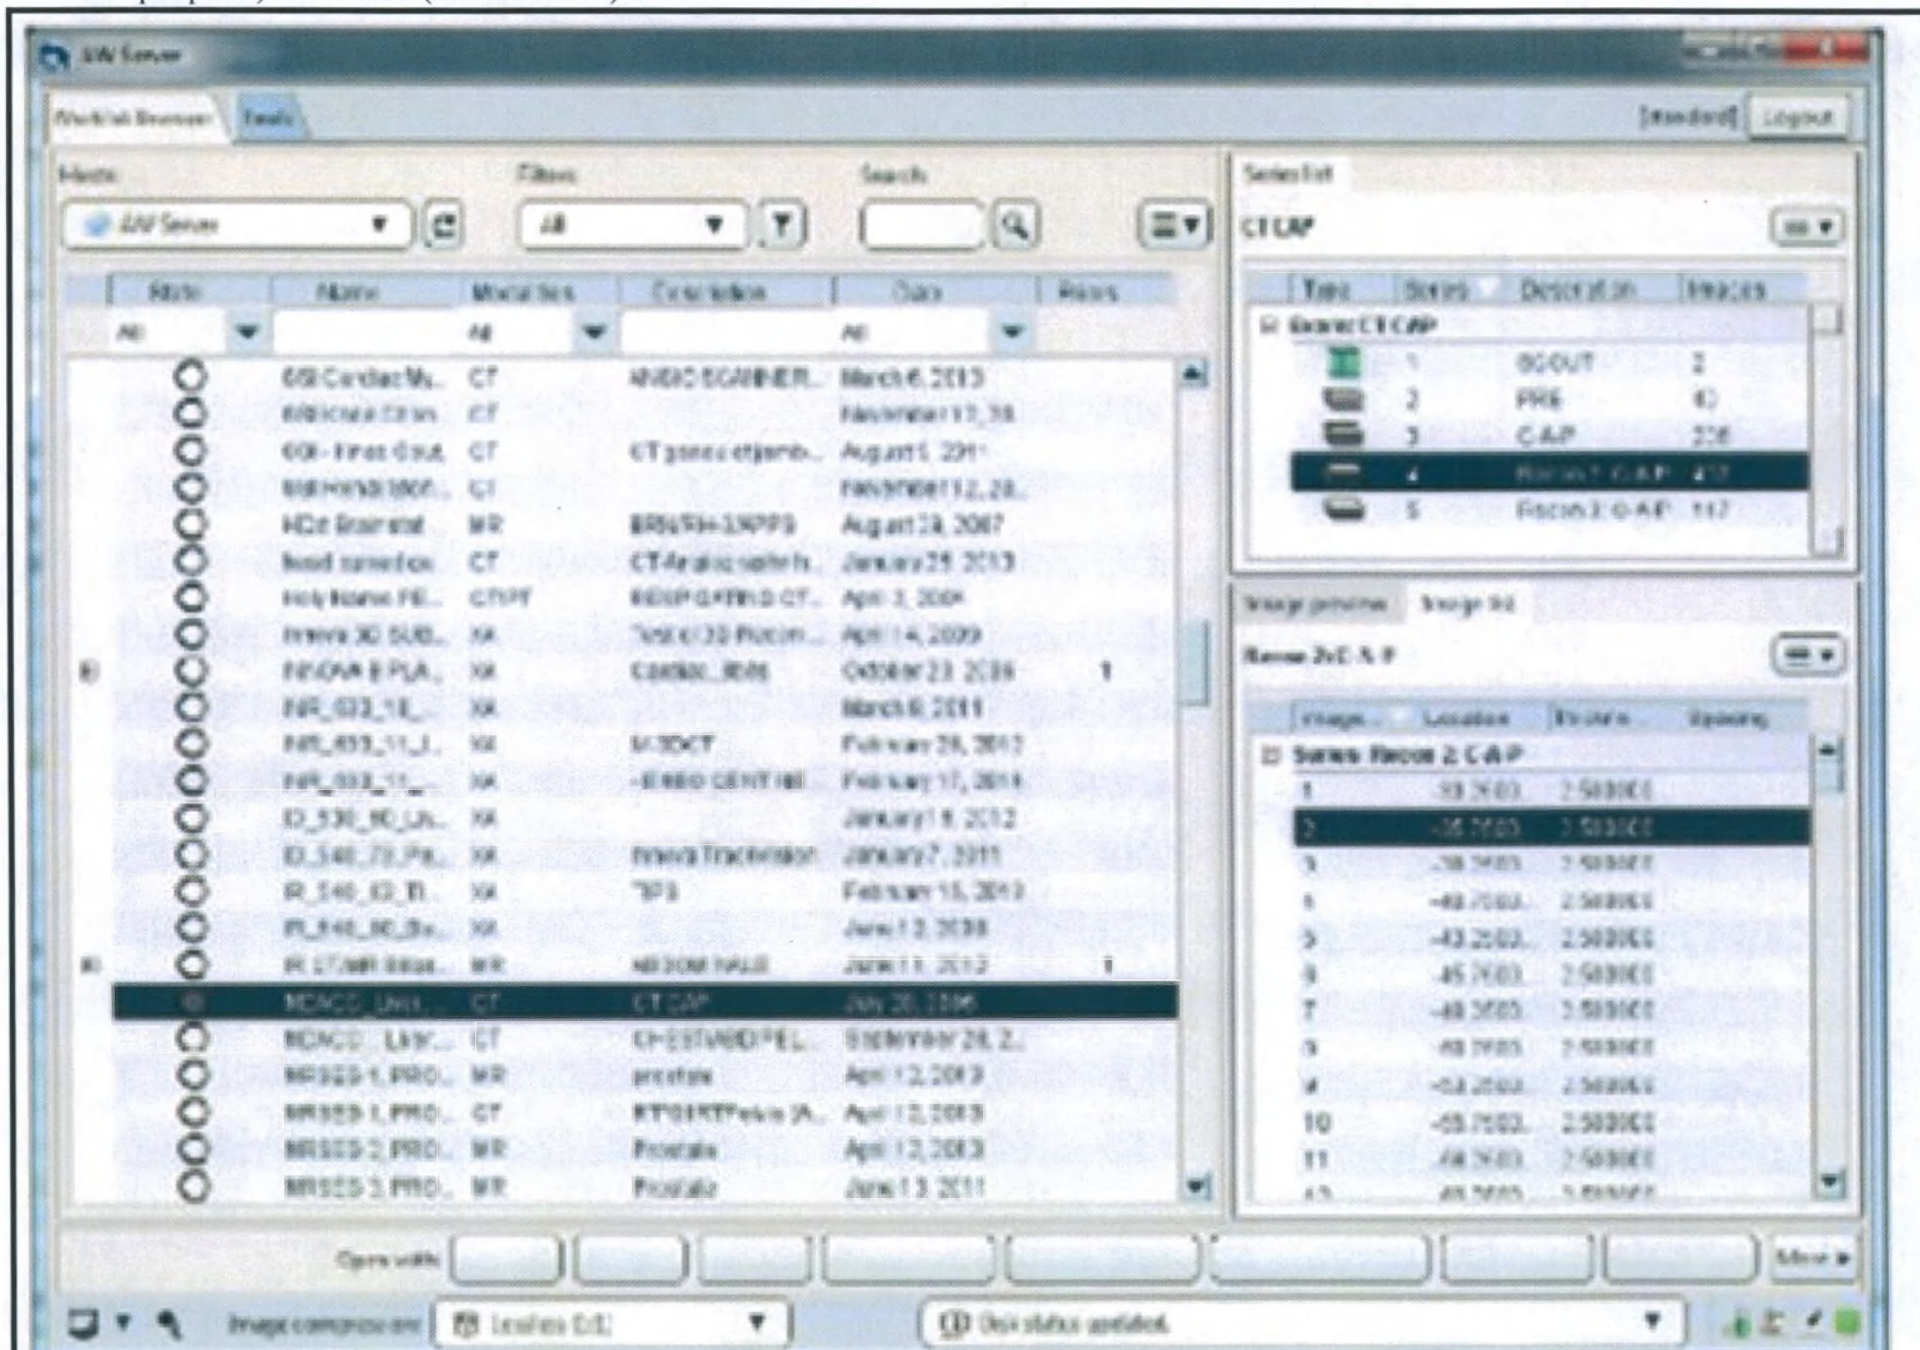

35. Программное обеспечение клиентского доступа на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).⁶²

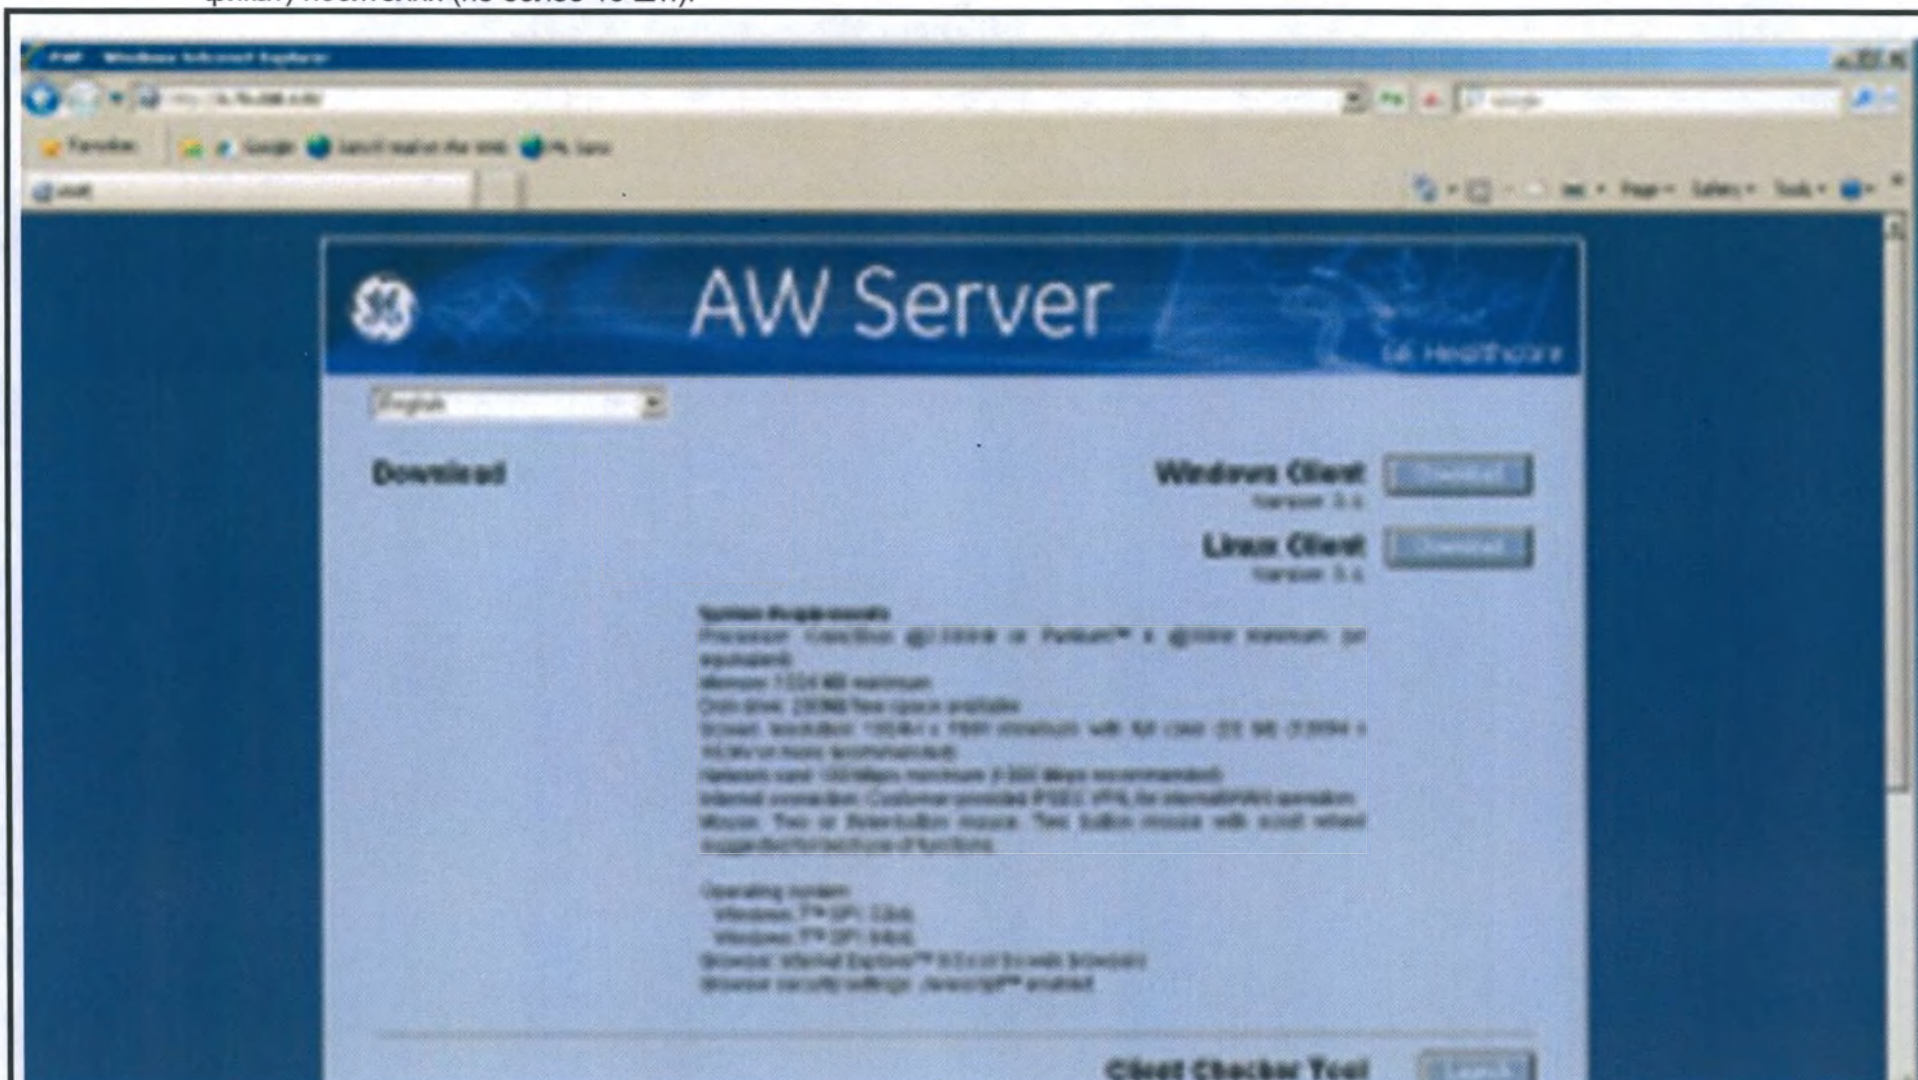

All Settings

 Anatomy Selection

I30.000 mm / S30.000 mm / 1-640 / 640 / Head / 25.0 cm /

A105.0 mm / R0.0 mm / AutoScan /

 kV and mA Control

Manual / 100 kV / Manual / 20 mA /

 Contrast

None / None / 0 ml / None / None / 0 ml /

 Timing

4.1 s / 2.0 s / Off, Off, Off /

 Scan Type

Axial / Off / 0.50 s /

 Coverage Speed

One / 160 mm / 10 / 3.00 s / 0.0 mm / 0.50 s / 5.00 s /


 Primary Recon


2.5 mm / Std / Off / 0 % / Off / 200 / 0 / None /

 Gating And Trace


Off /

3/ Программный пакет обновления программного обеспечения рабочей станции на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

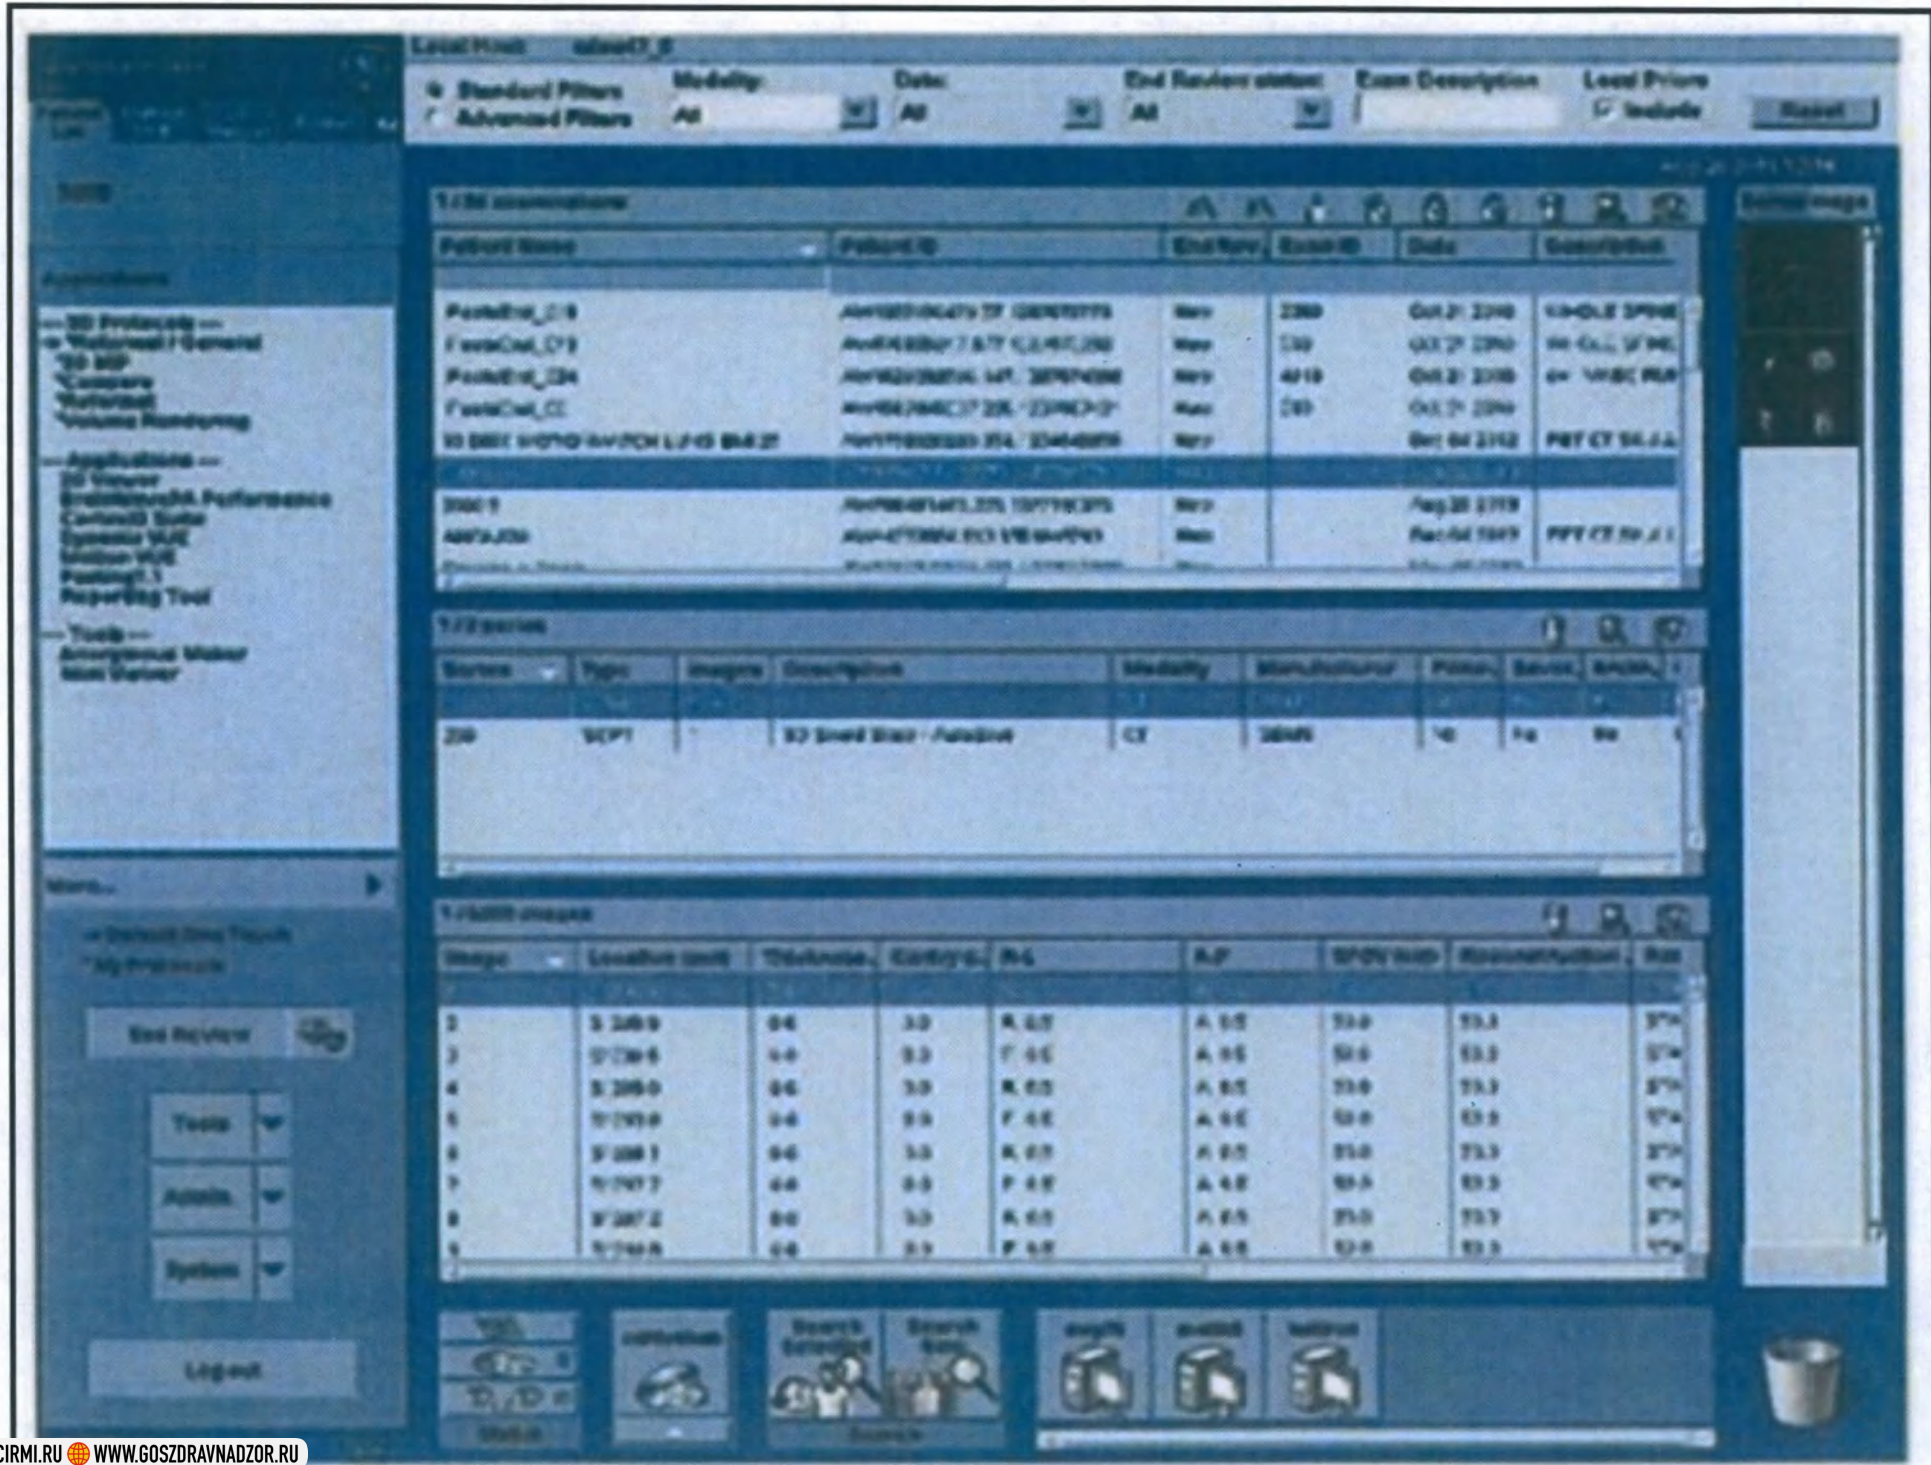


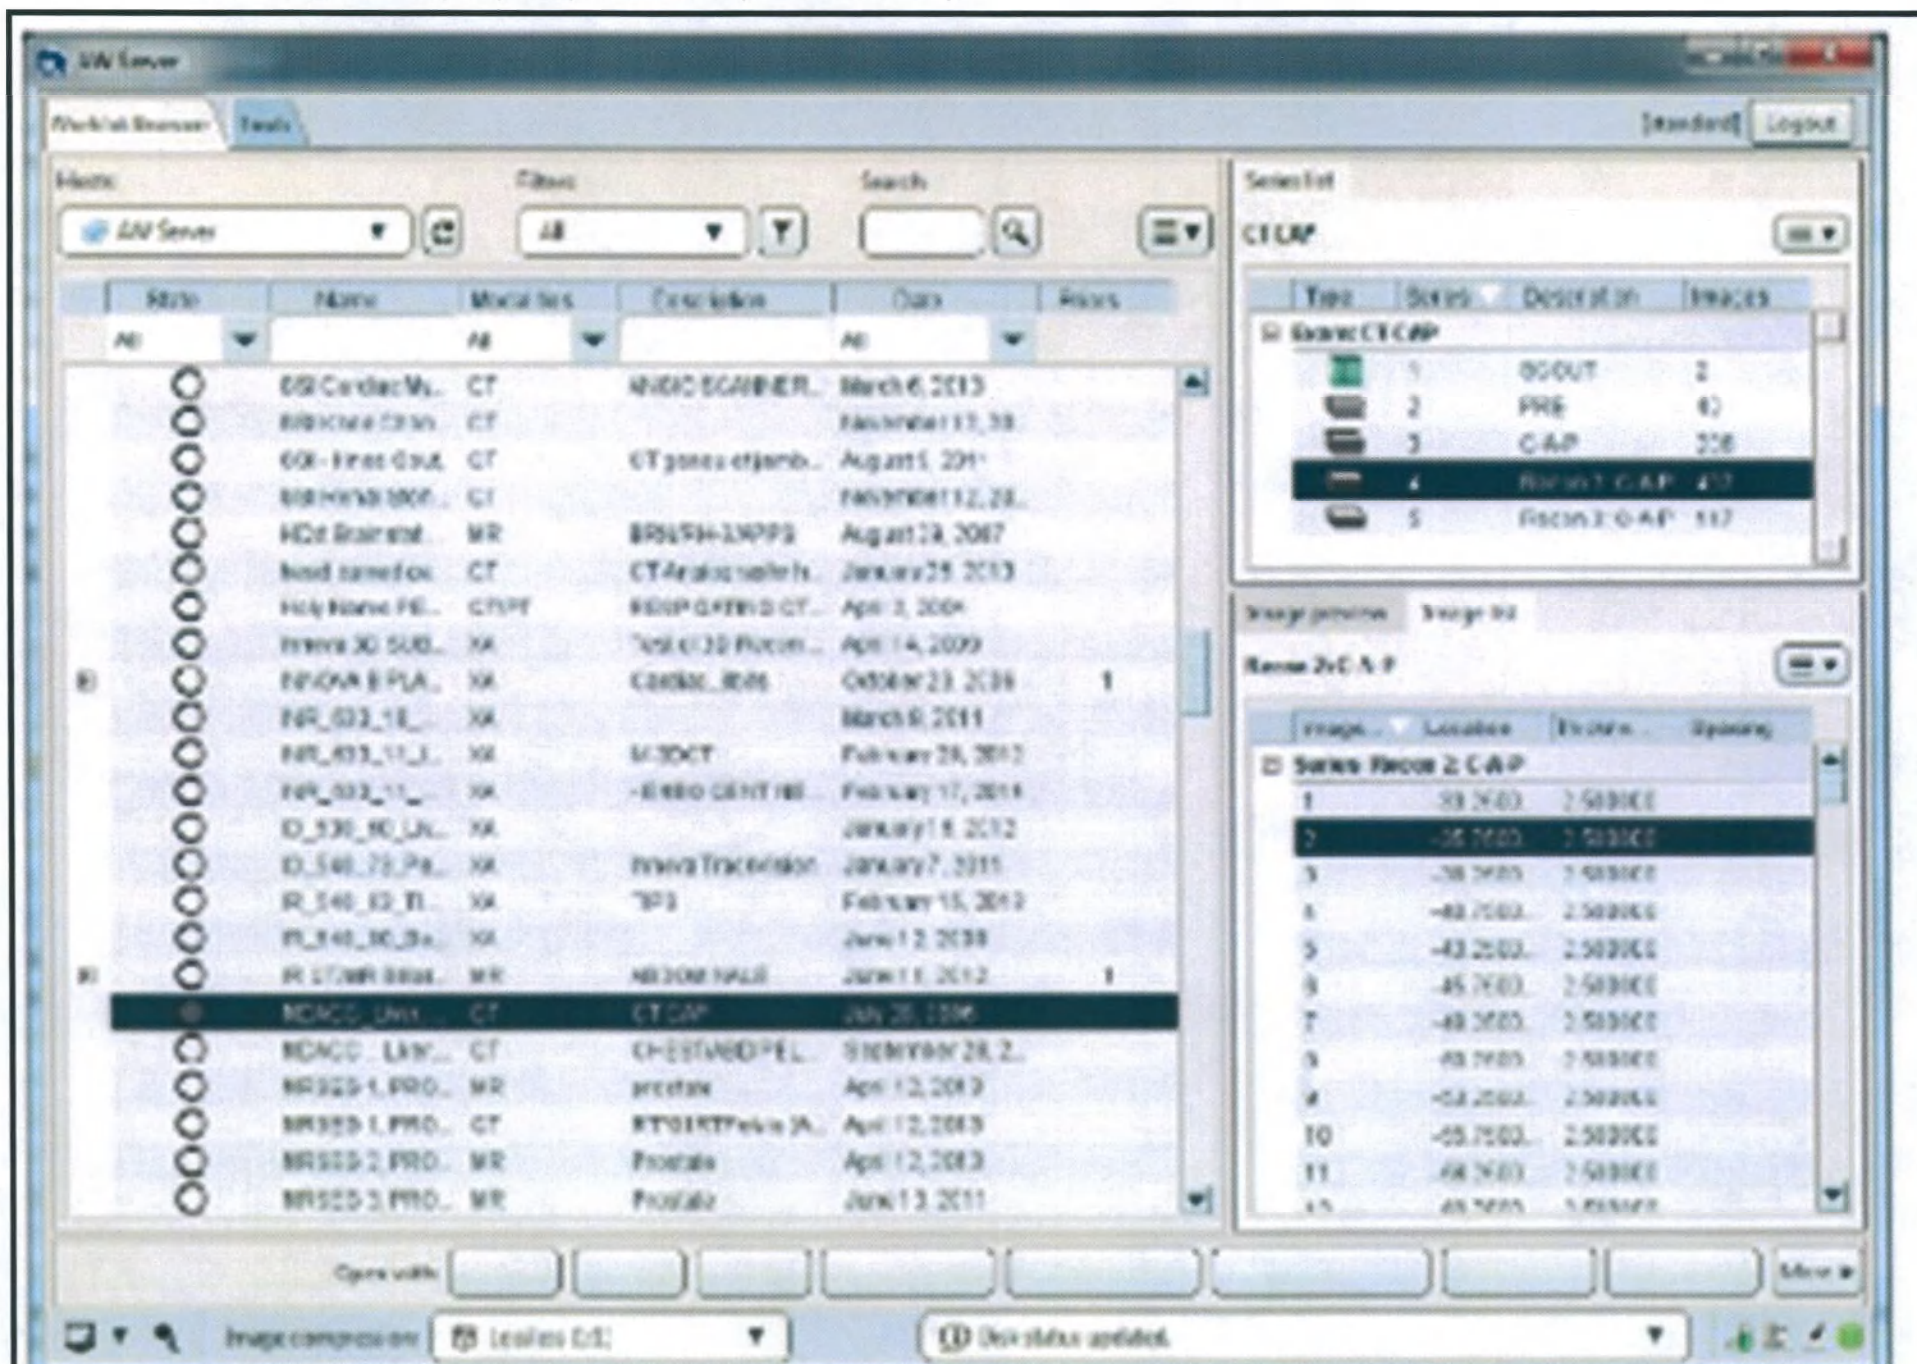

39. Программный пакет для сканирования на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

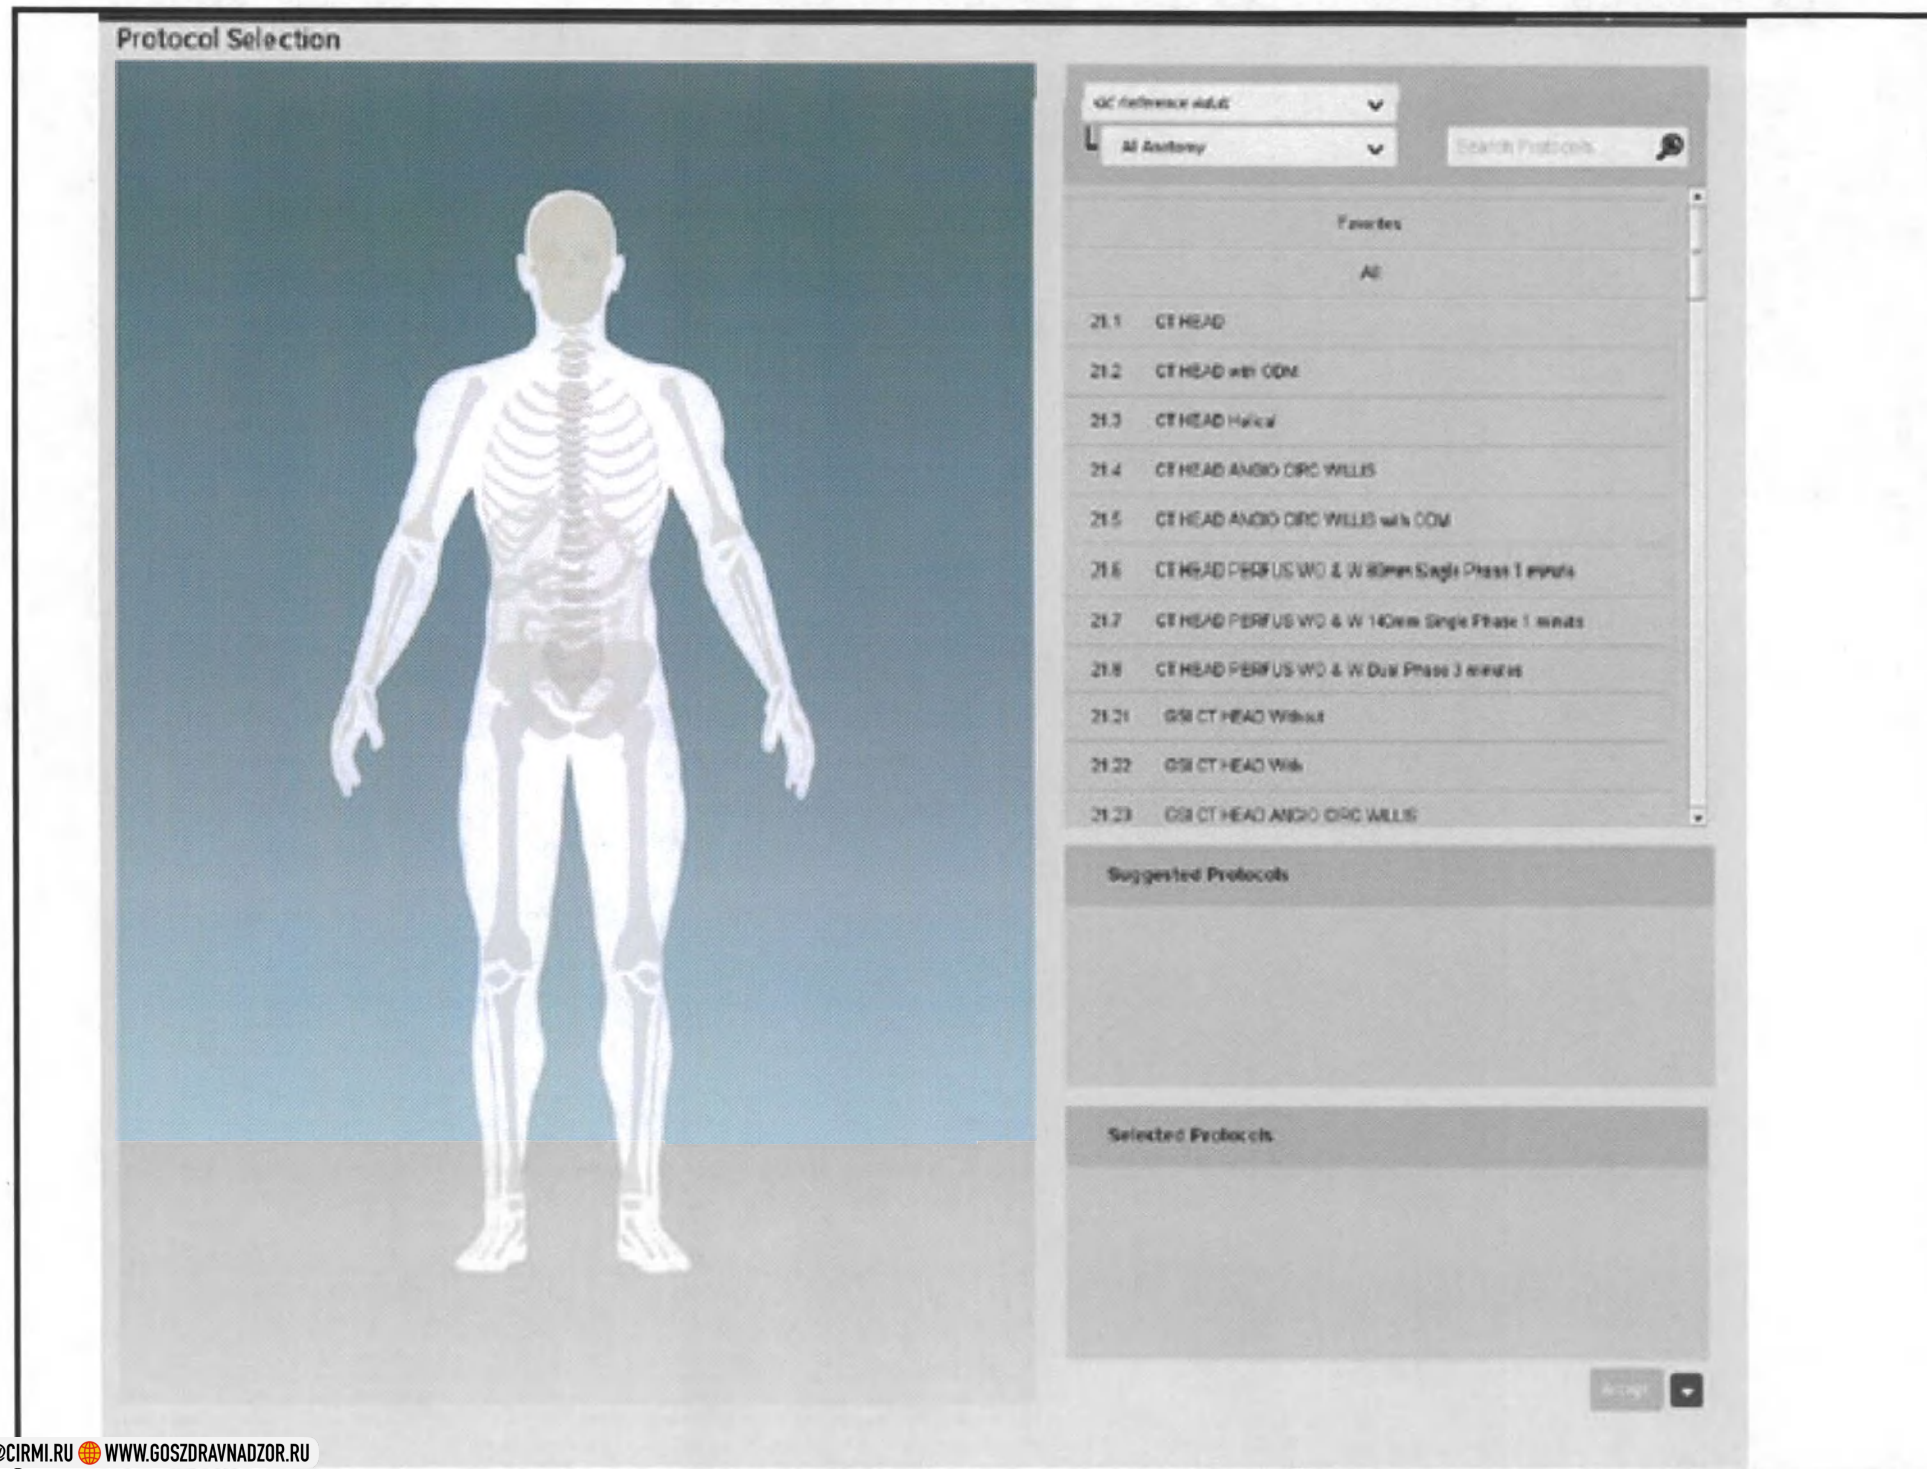

40. Программный пакет для анализа объемных изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).

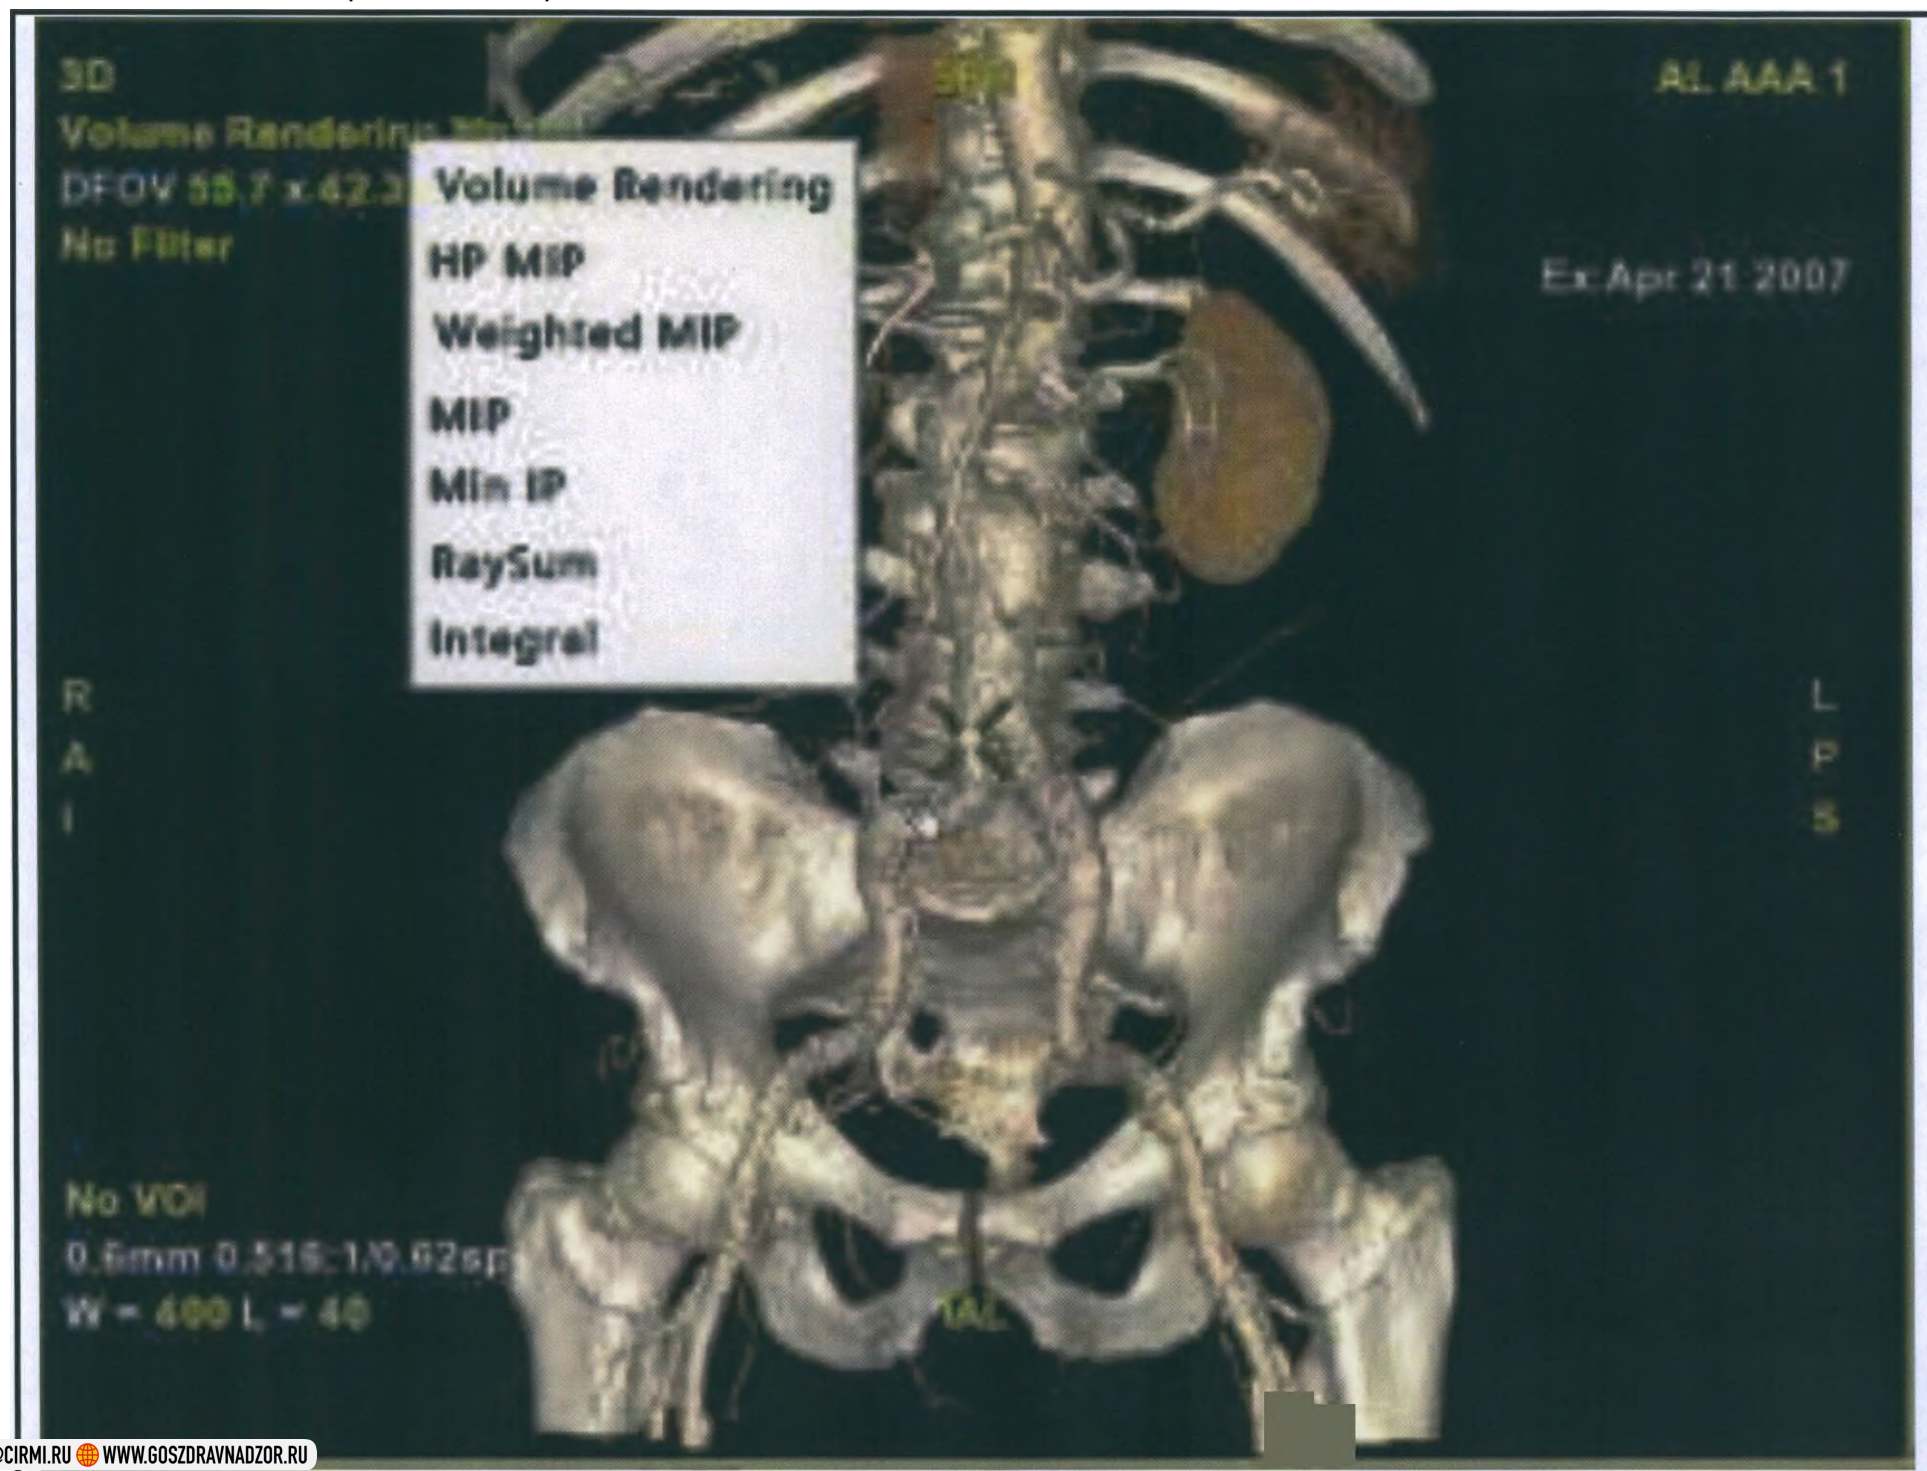

41. Программный пакет для разделения данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 20 шт.).

Patient Name	Exam Description	Patient ID
REV KNEE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	AW54544
REV TAVI	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	AW19978
REV TAVI	ANONYMIZED	AW99890
REV CARD	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	AW16224
REV CARD	ANONYMIZED	AW12298
rep img 2		rep img 2
rep img		rep img

Open exam

Send Exam To ▶

Anonymize Patient

Edit Patient

Exam Split

Add / Sub

Reformat

Vol Viewer


Send PPS ▶

Delete Exam

Exam Split

42. Программный пакет для сегментации костных структур на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).



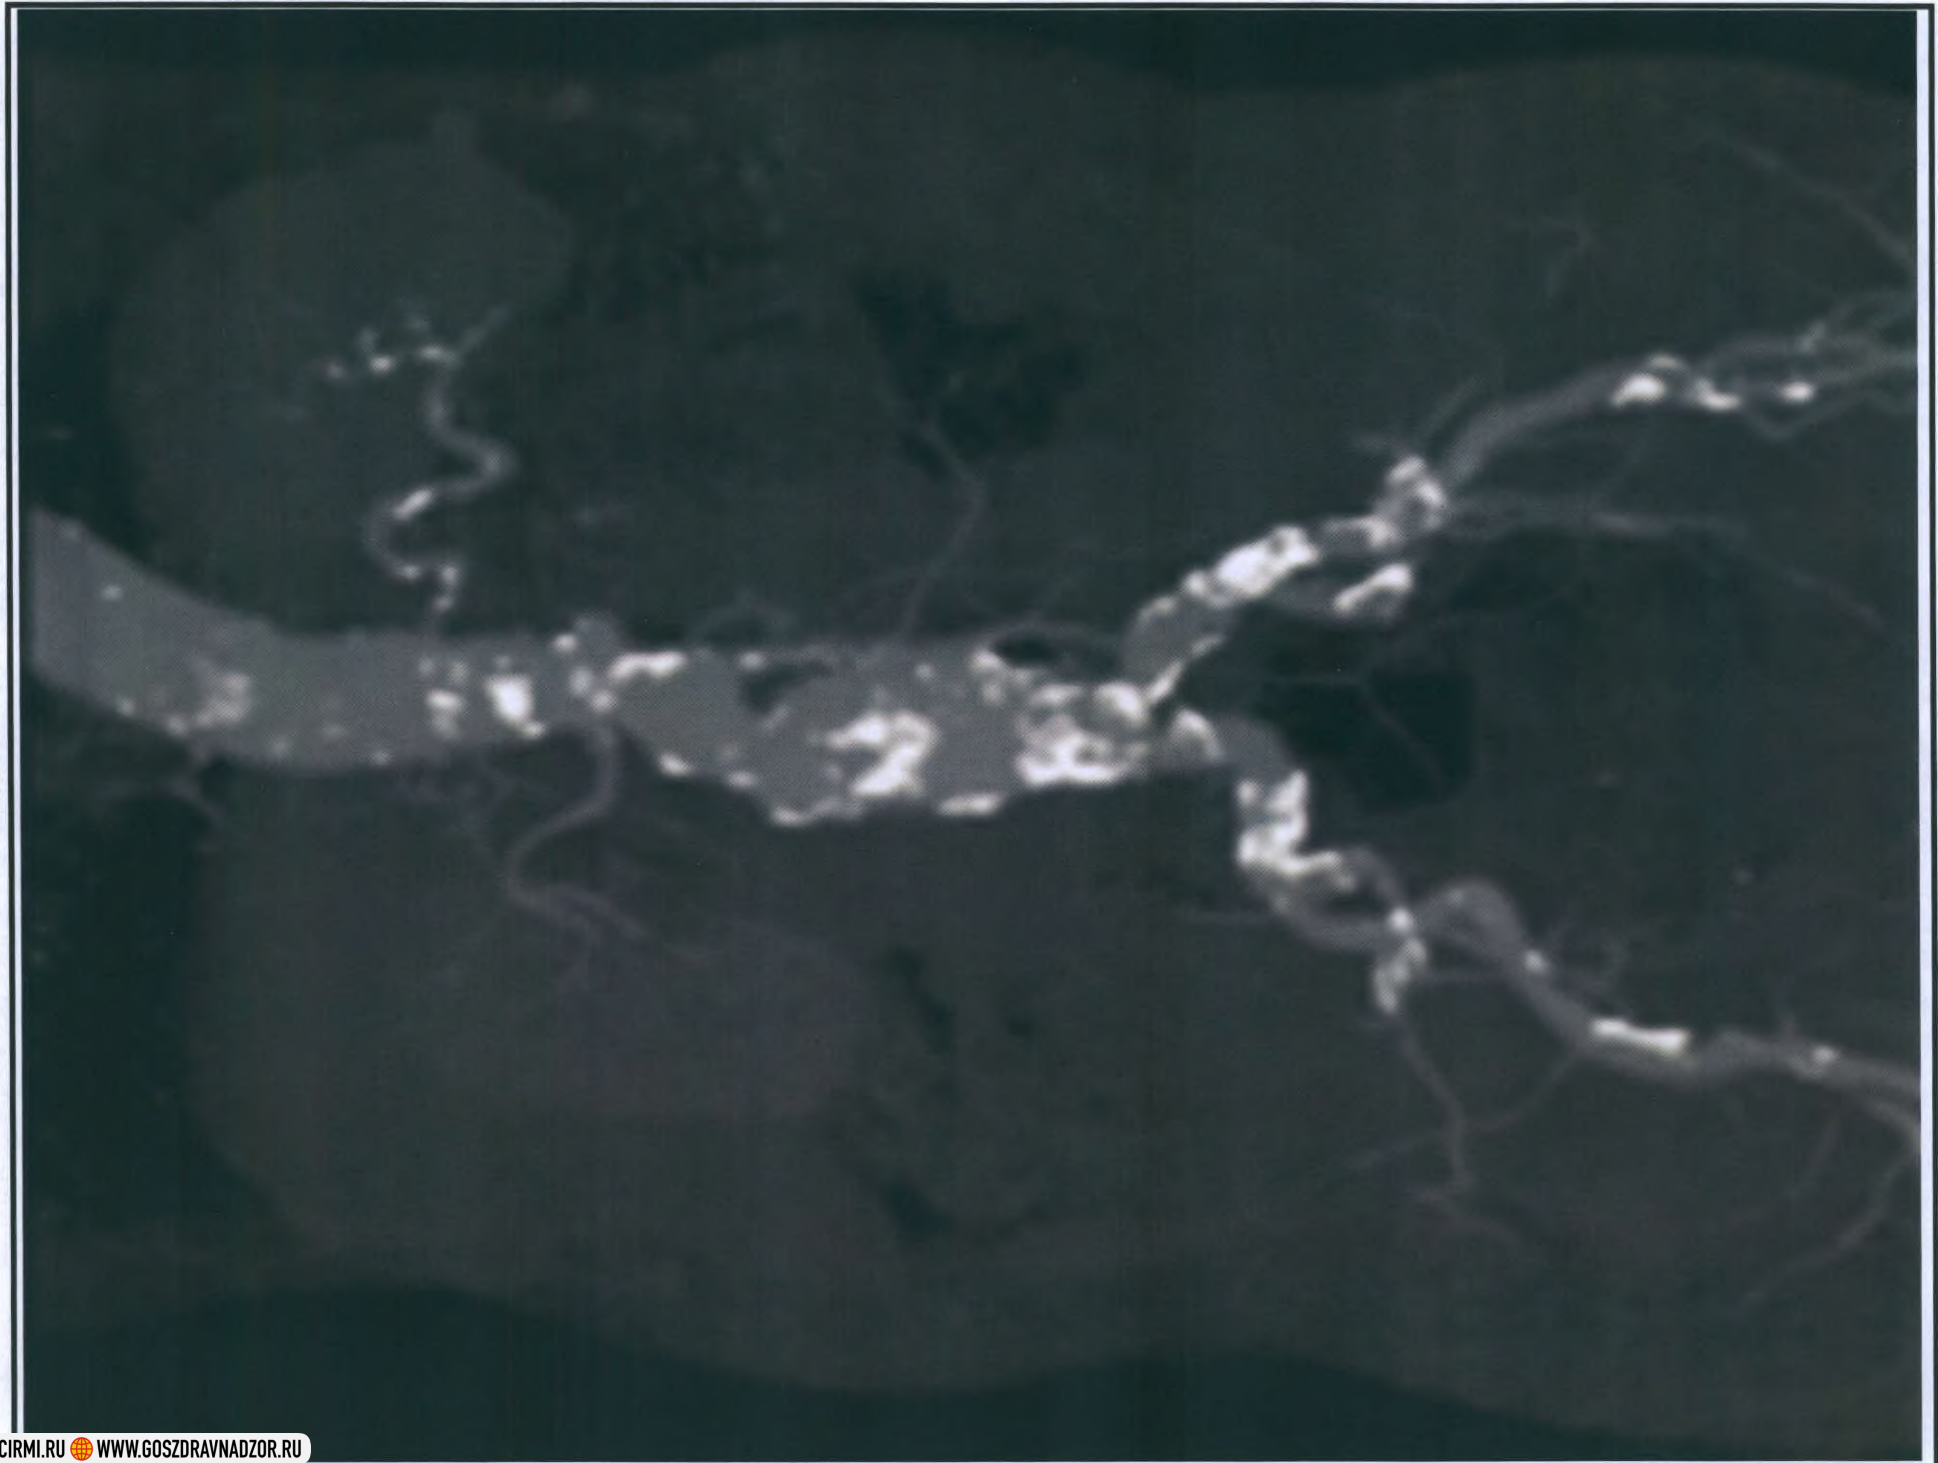





45. Программный пакет для кардиологии на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).





46. Программный пакет для анализа кардиологических и электрофизиологических изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).

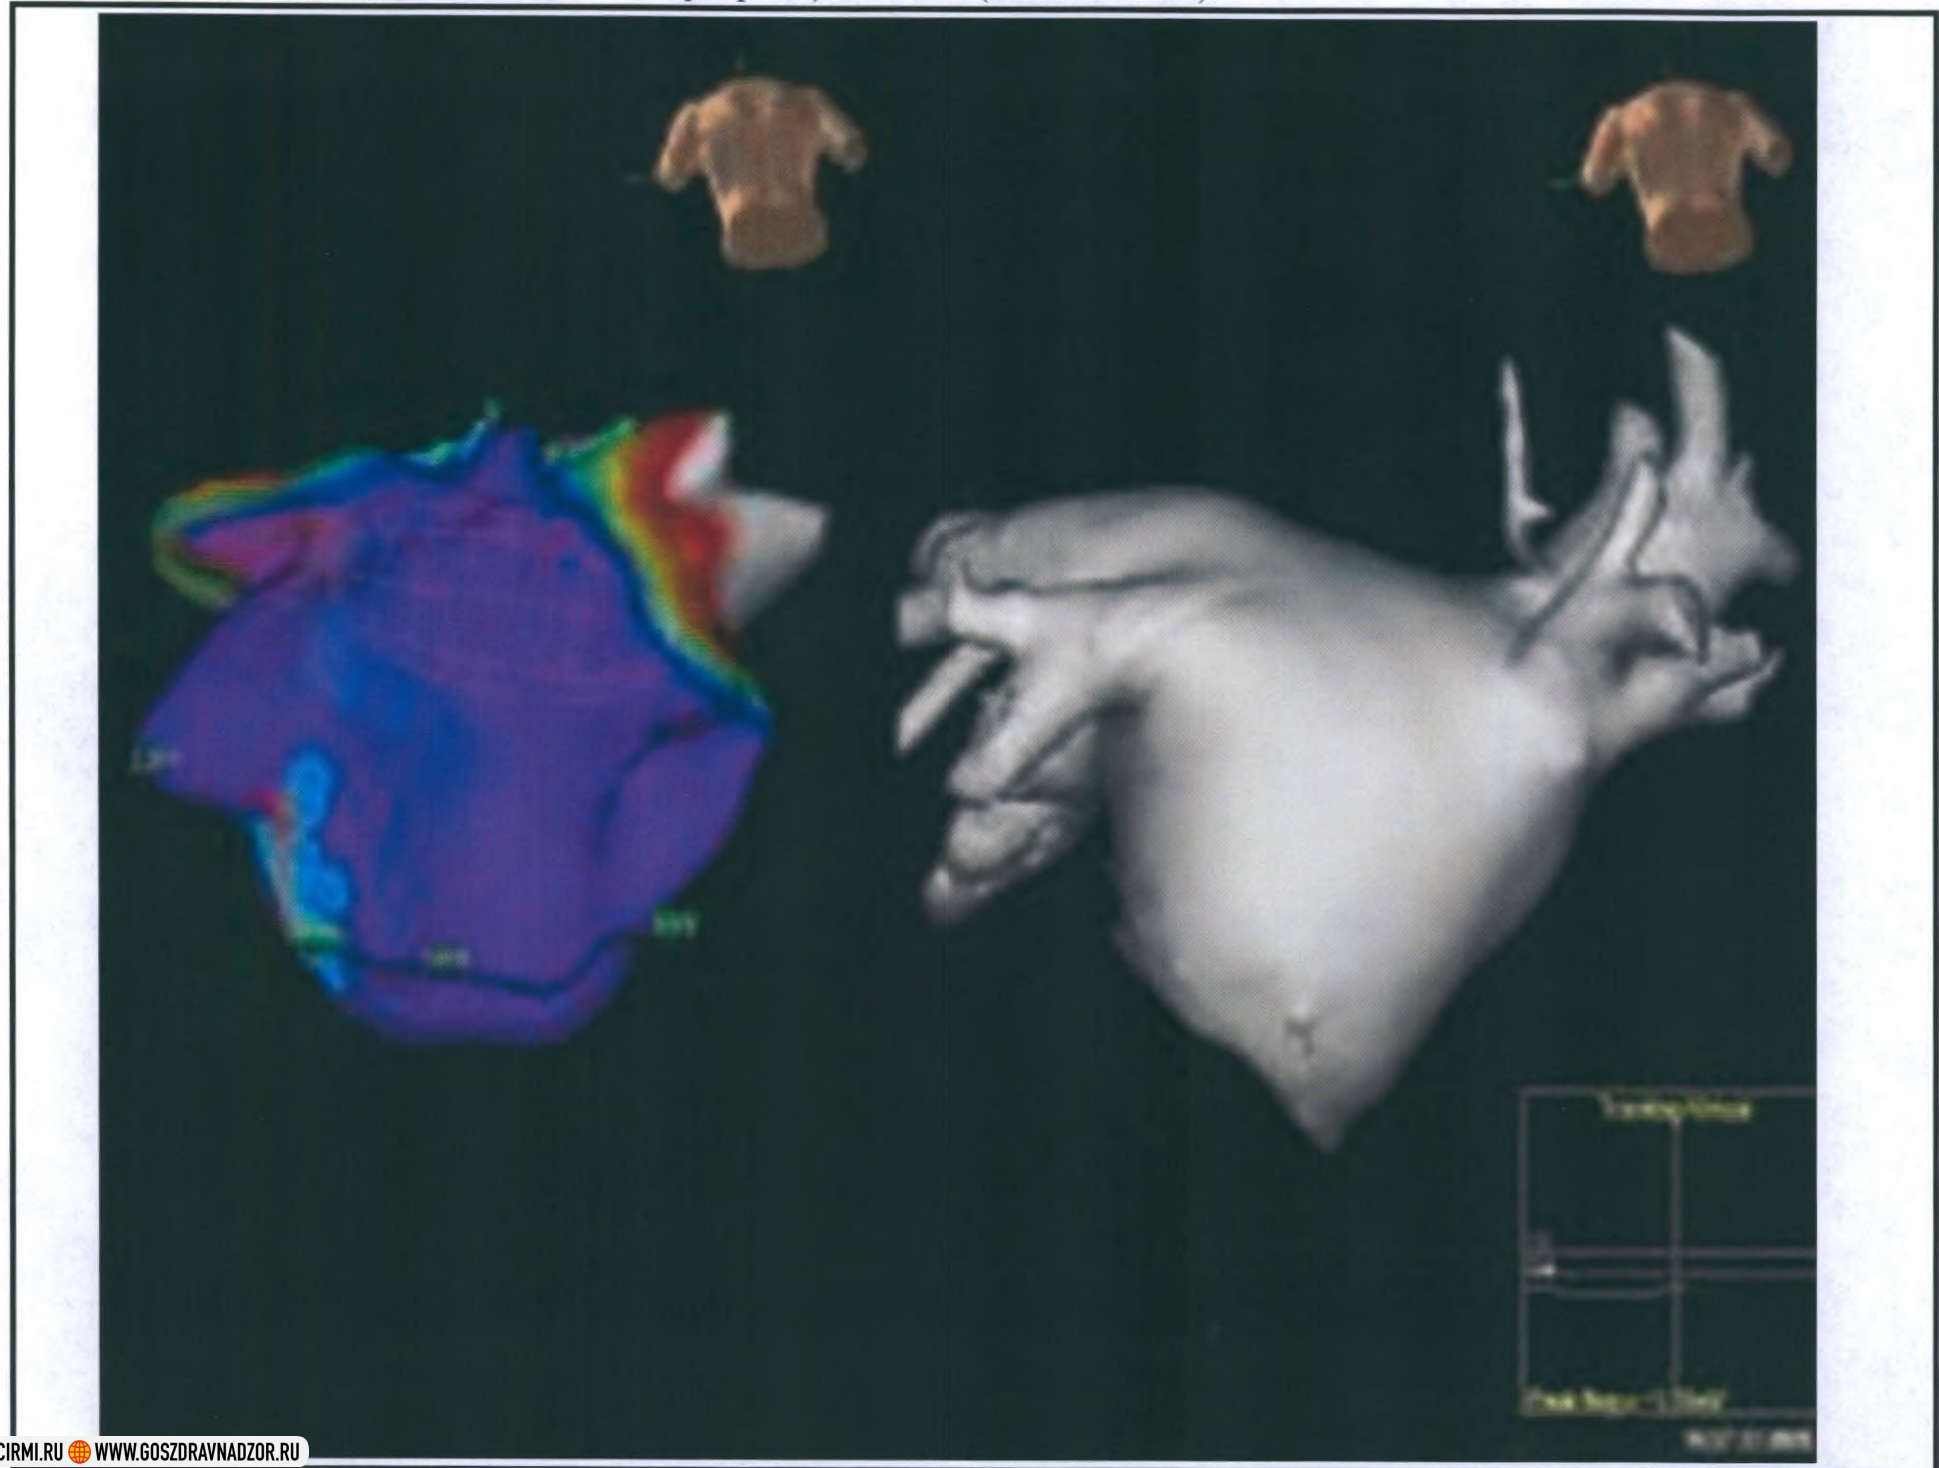


47. Программный пакет для оценки кальцинирования атеросклеротических бляшек на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

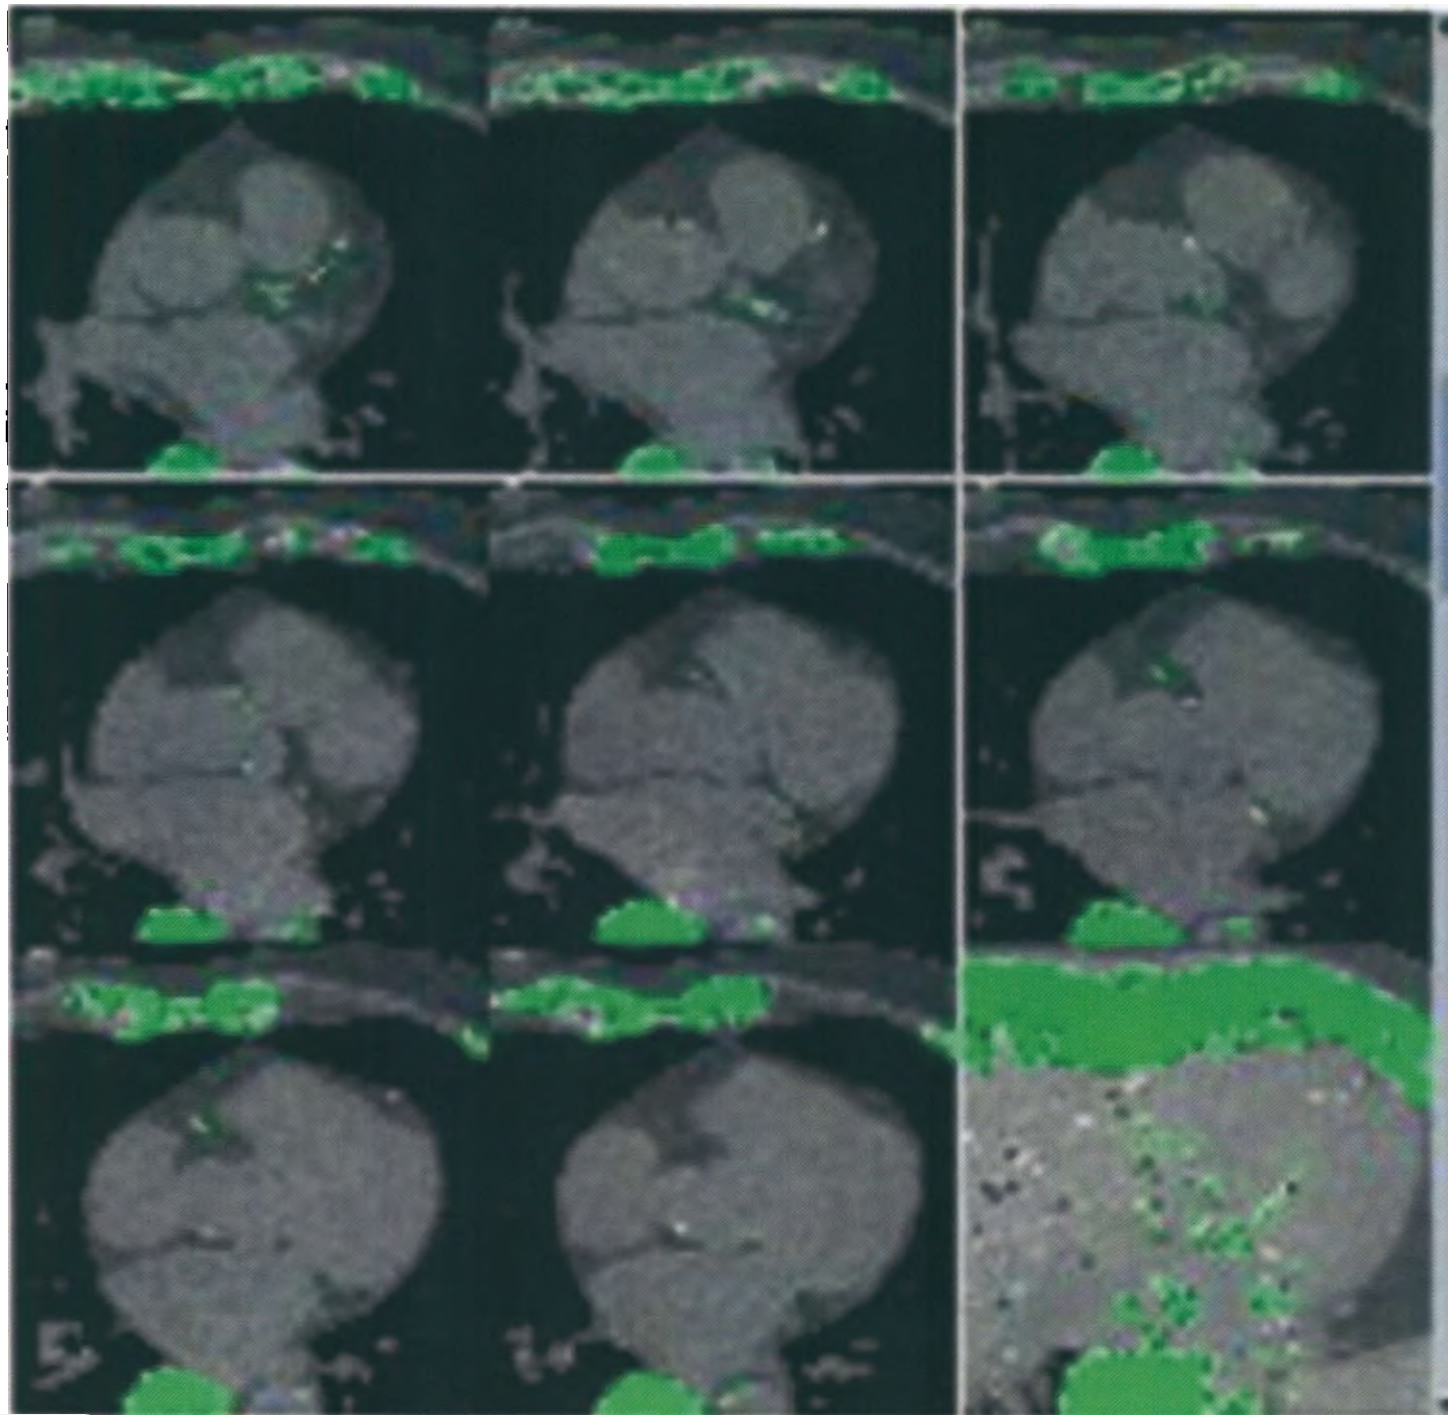


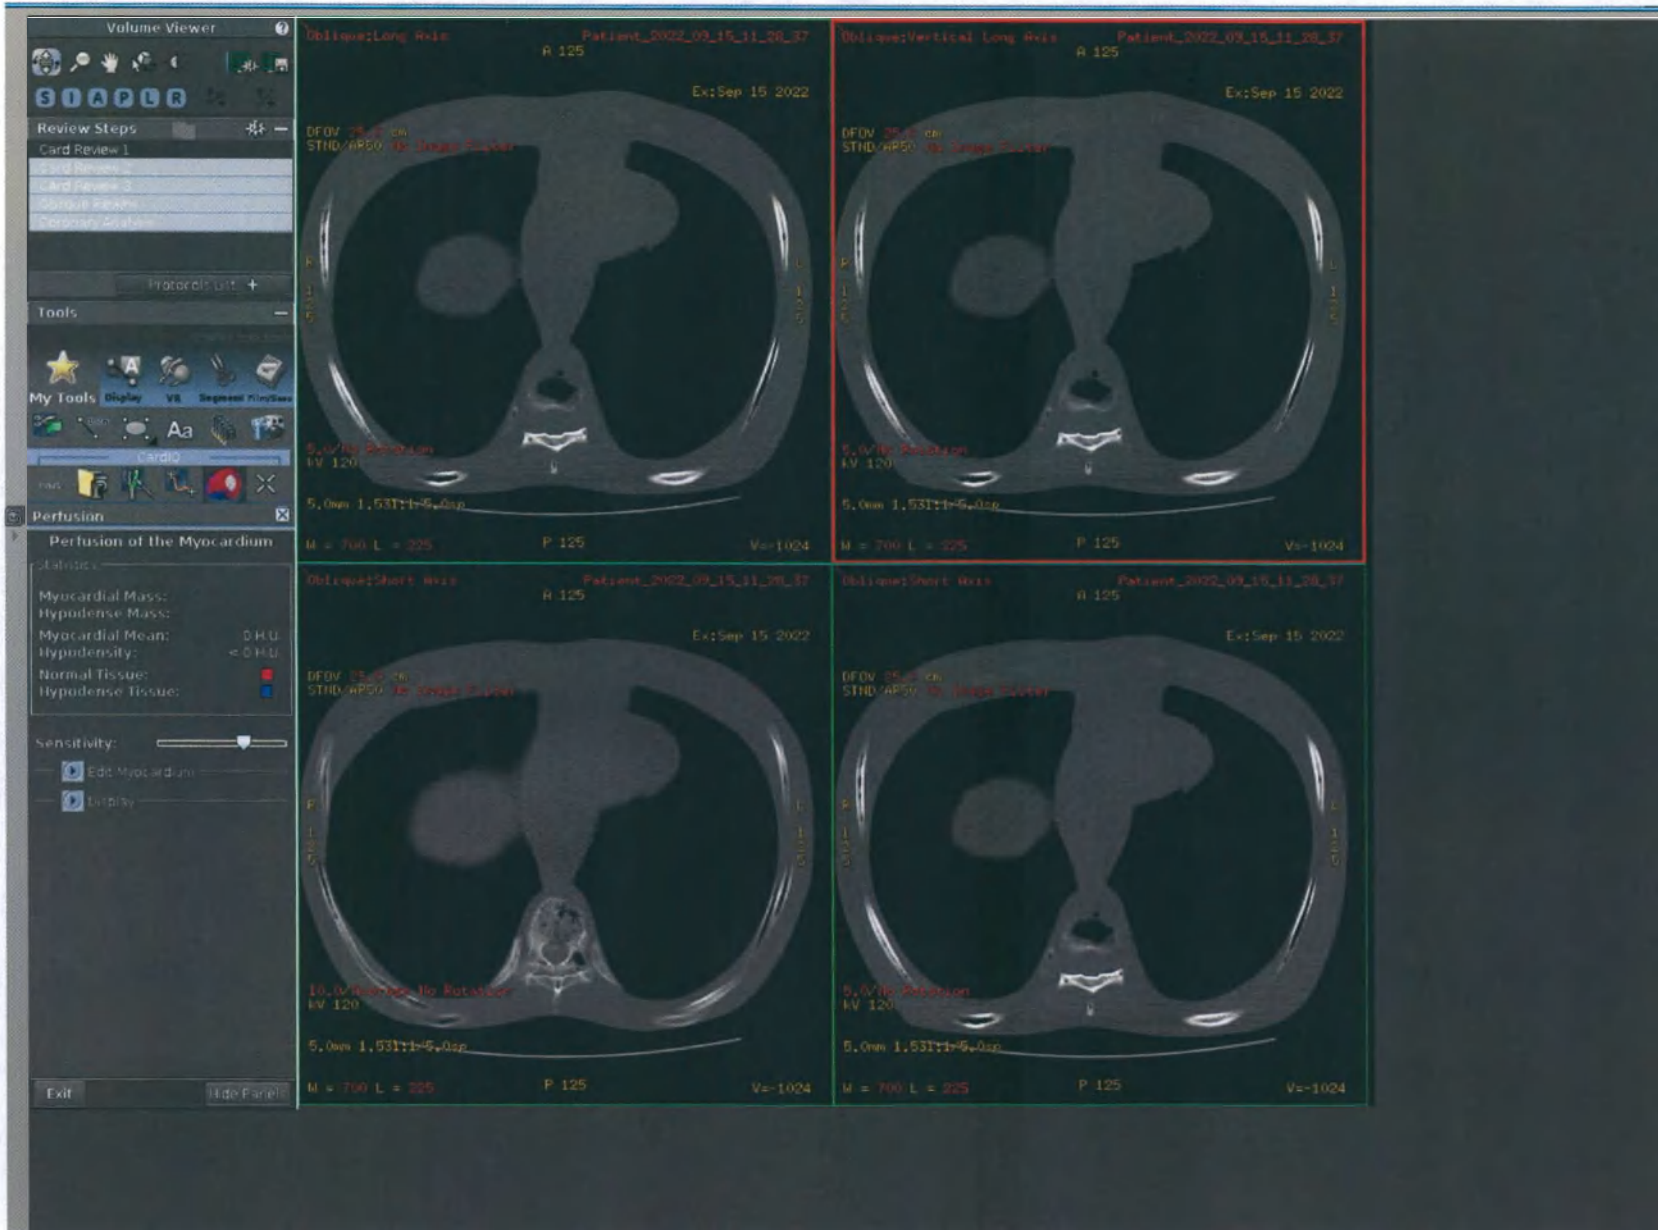75
КЛЮ

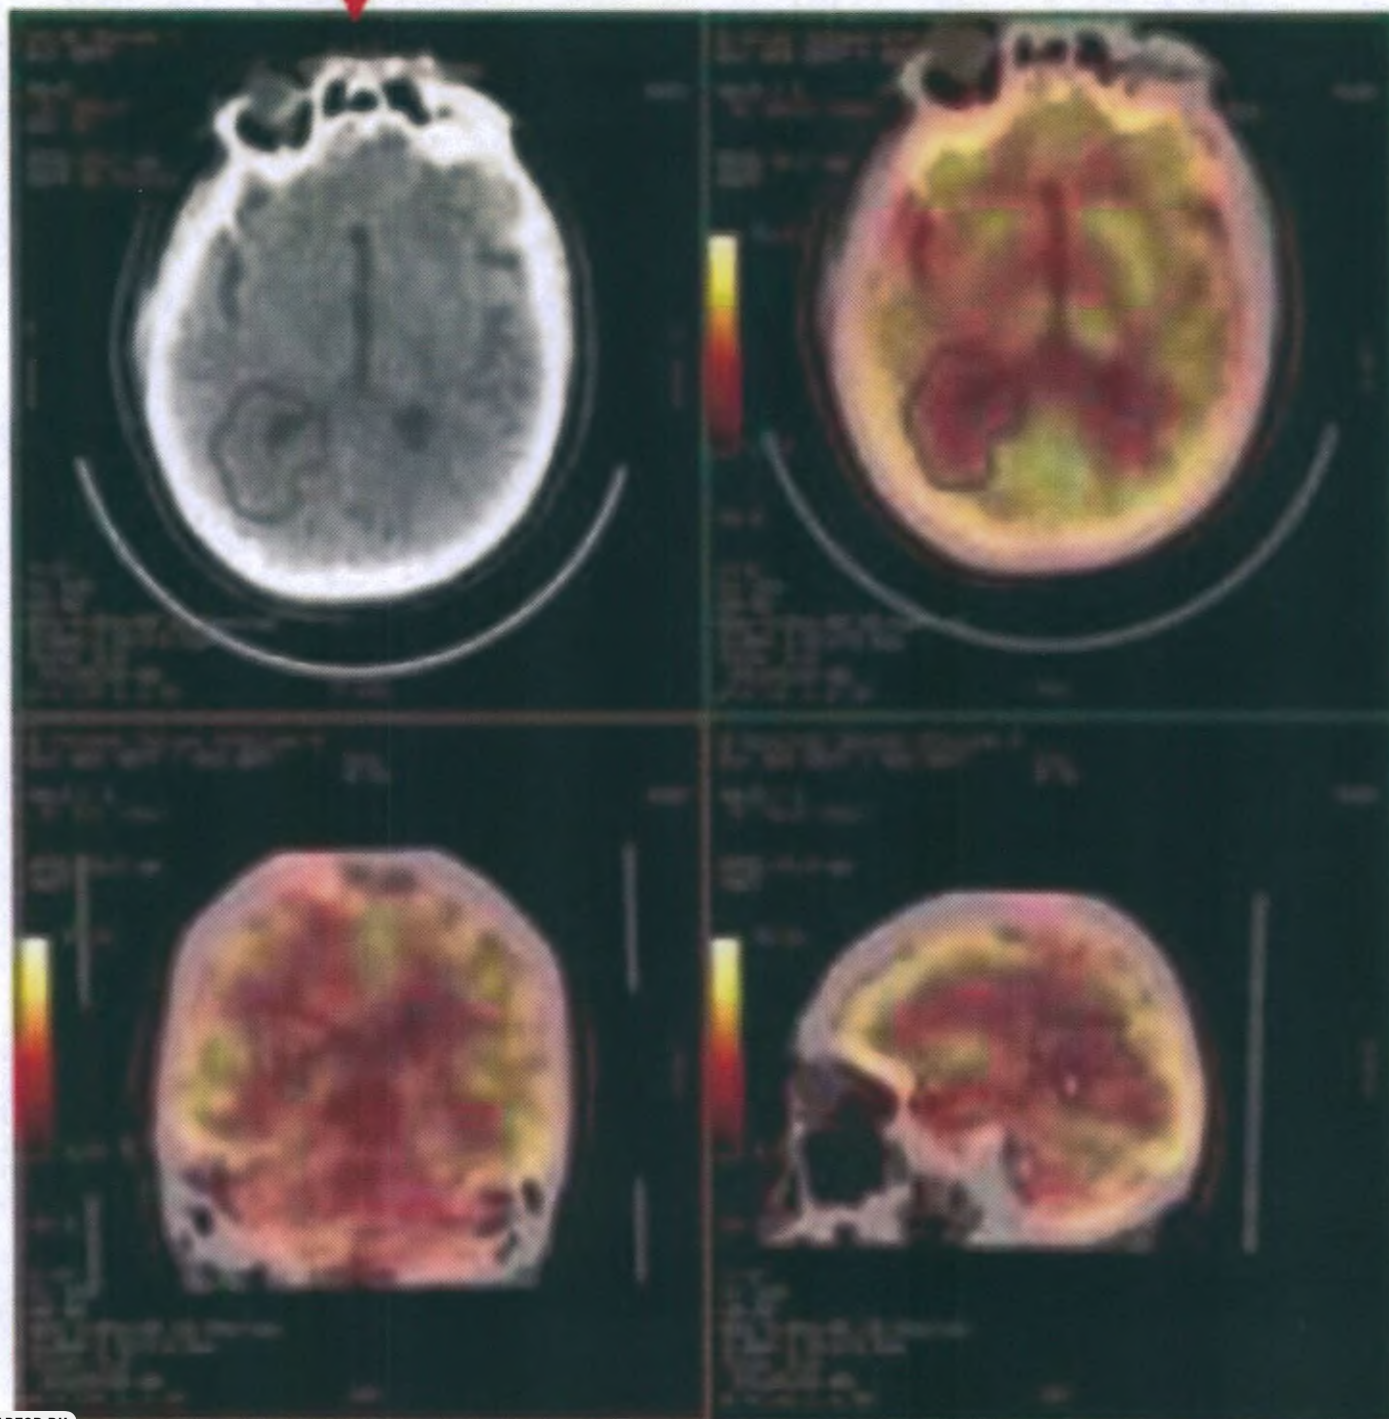

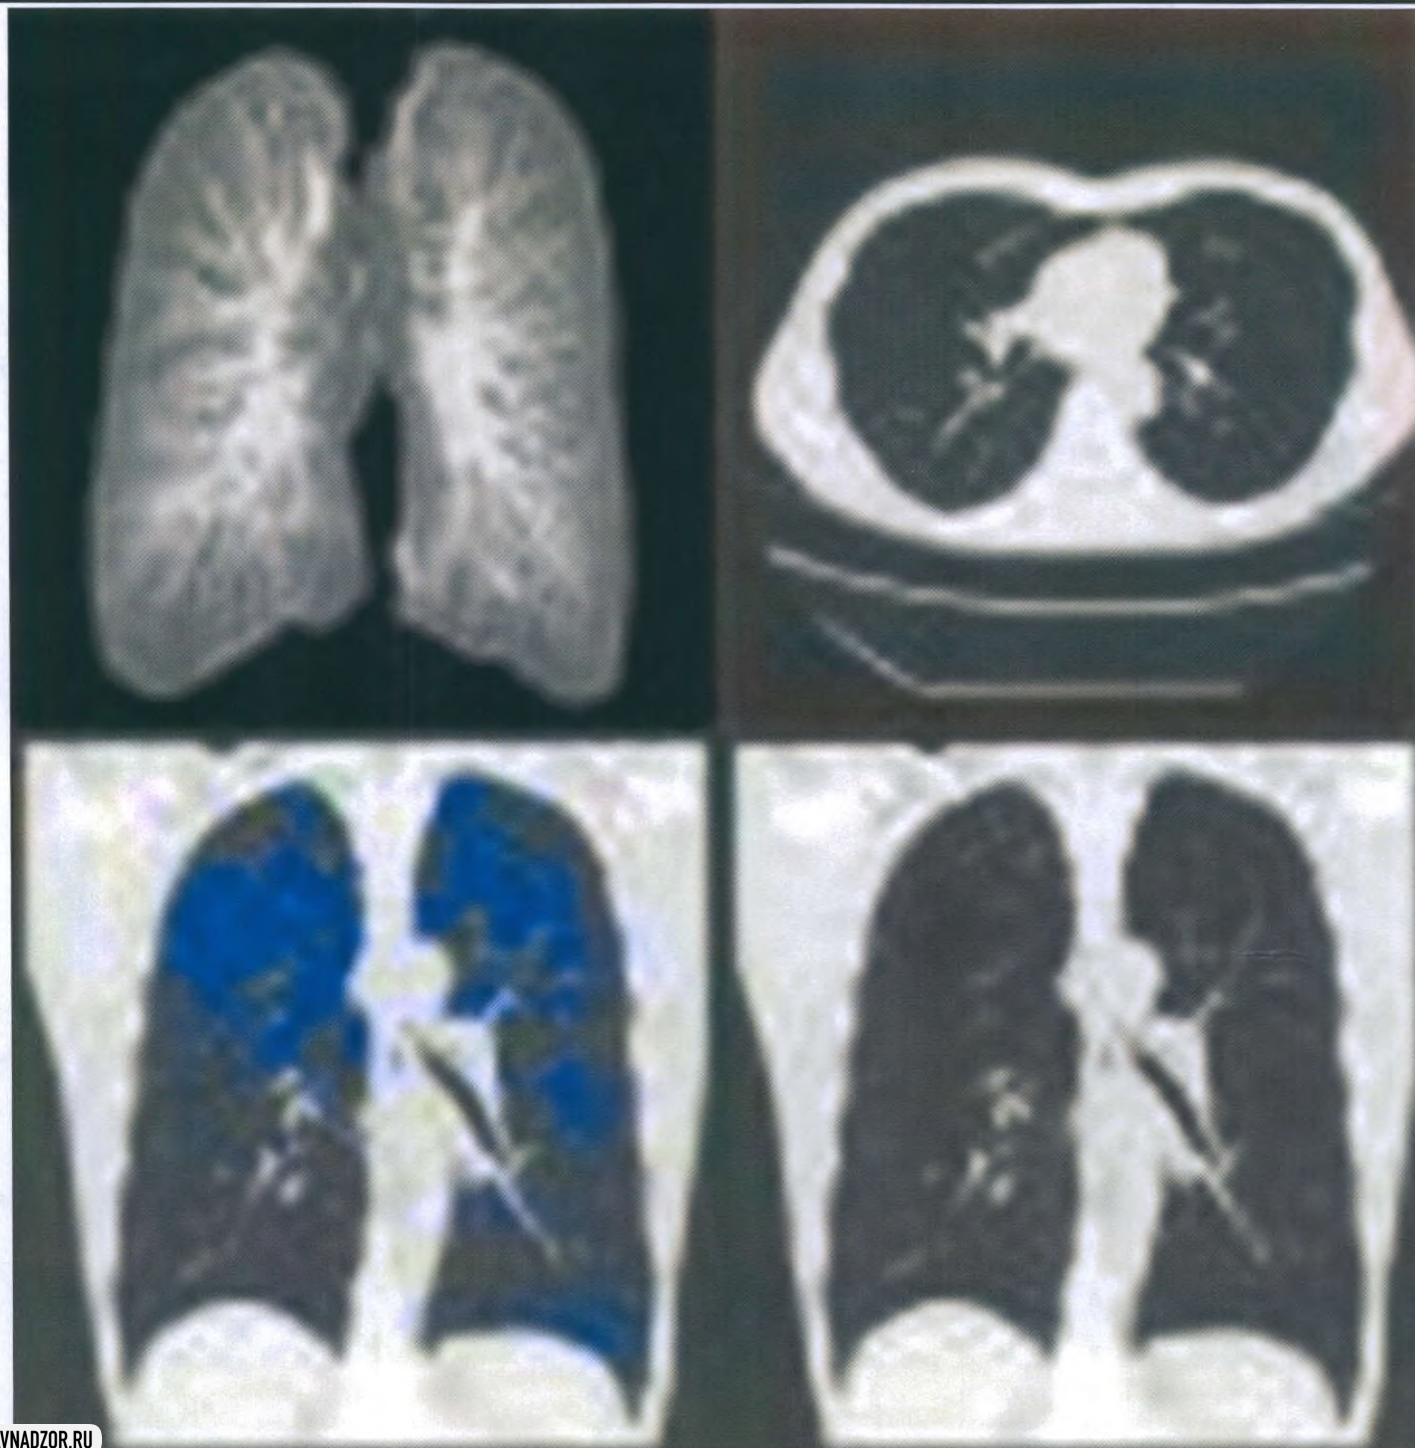


51. Программный пакет для подготовки геометрических и анатомических данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).

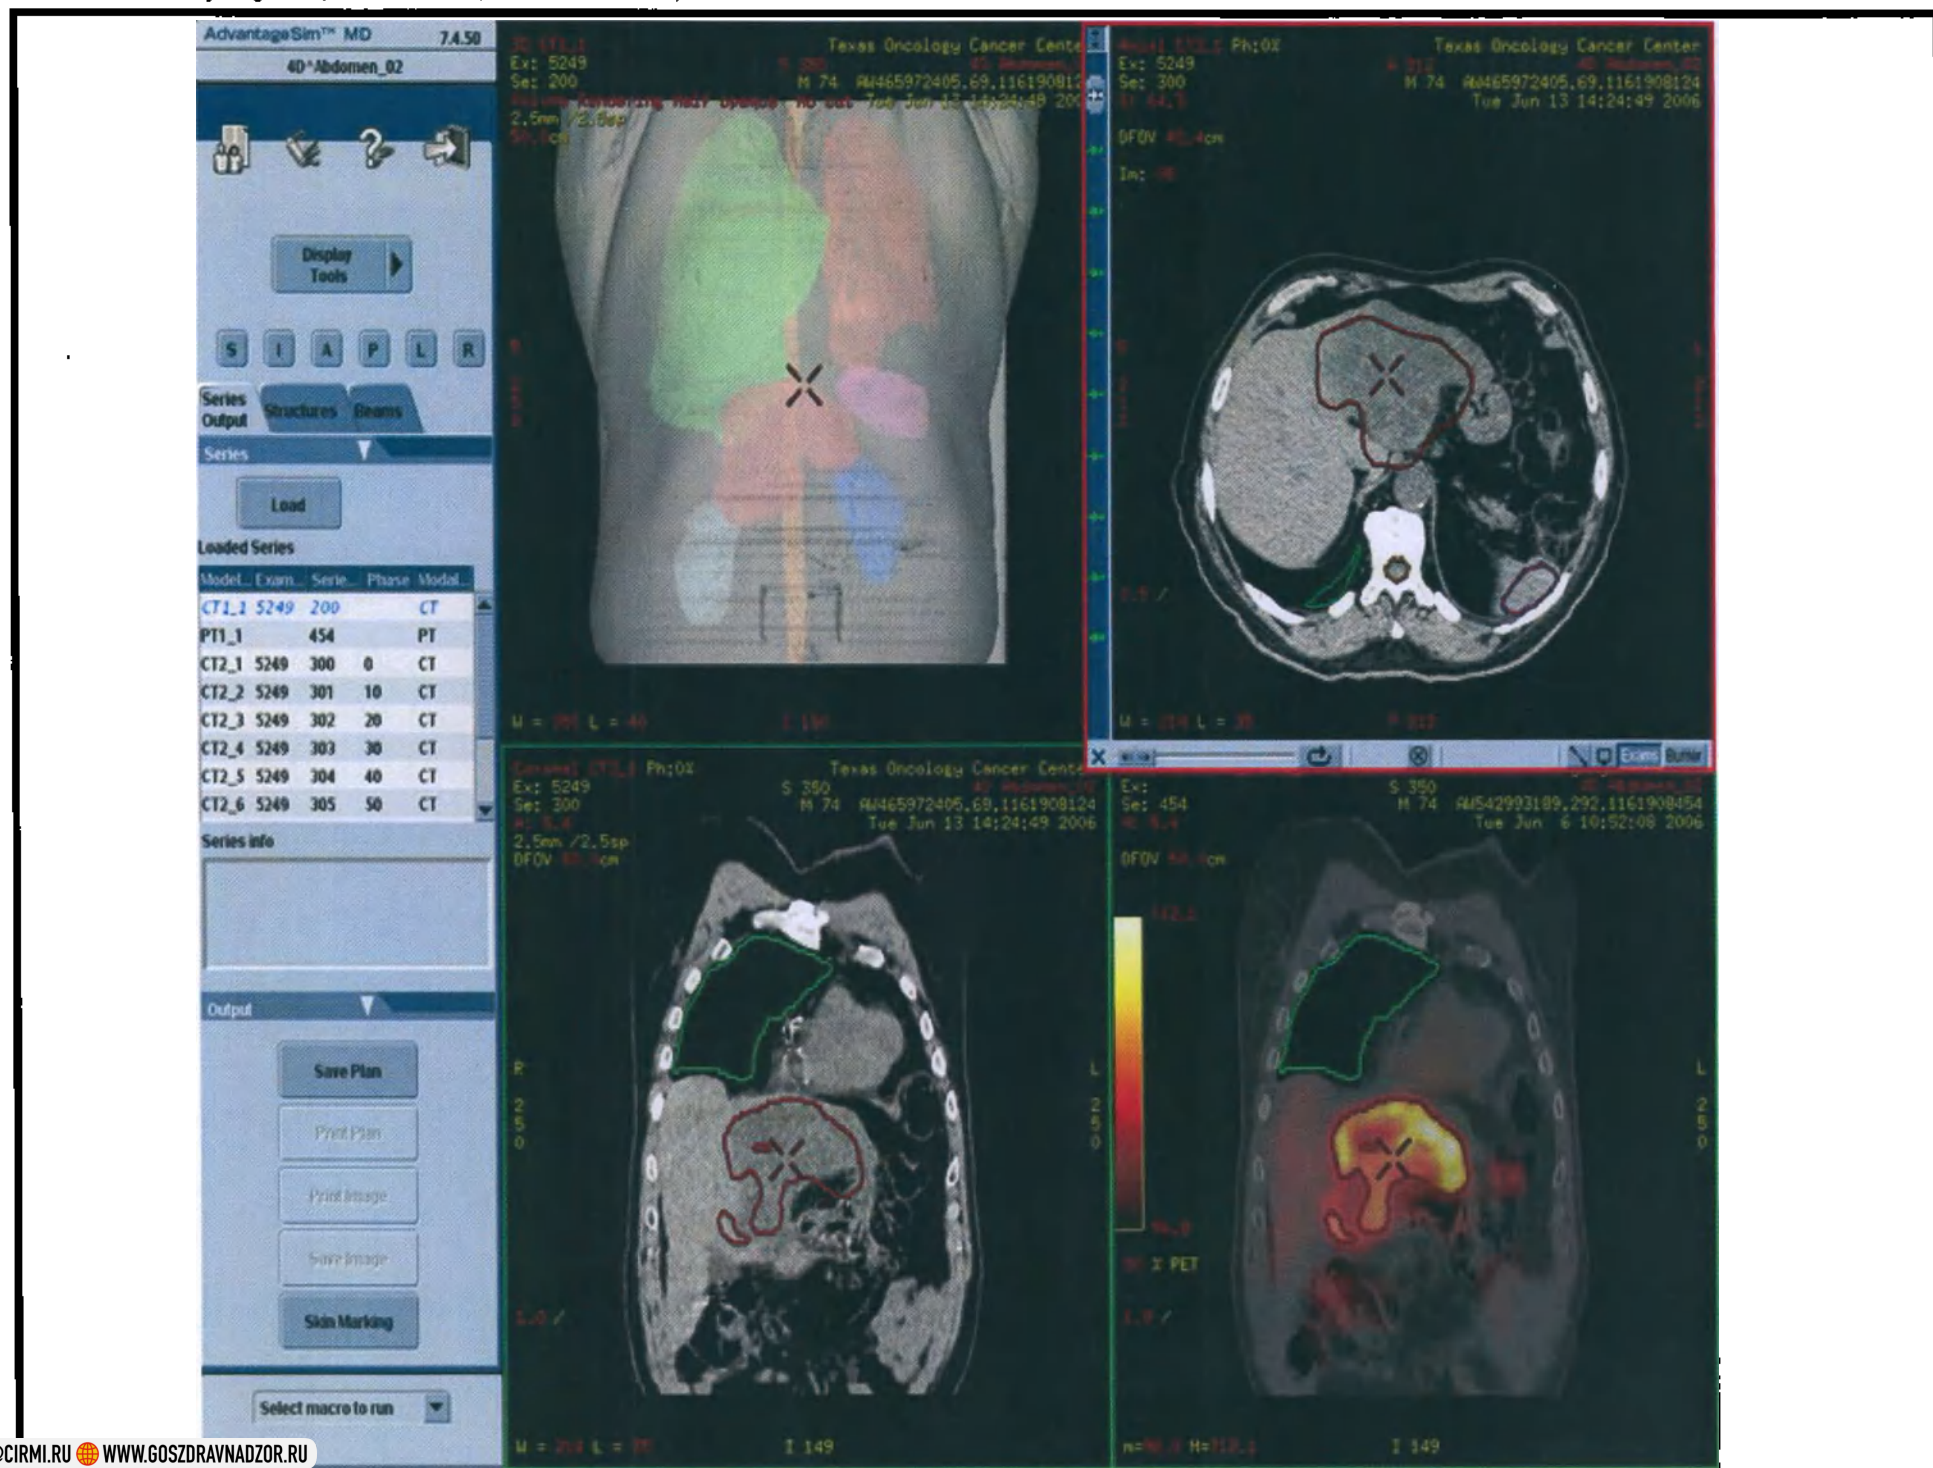

Recon Settings


Thickness	0.625 mm
Recon Type	Stnd
Enhanced Contrast	Off
Recon Mode	Helical Plus
IQ Enhance	Off
Interval	0.6250 mm
Image Enhance Filter	None
ASiR-V	50%
MAR	Off
Window Width	400
Window Level	40
Flip / Rotate	None

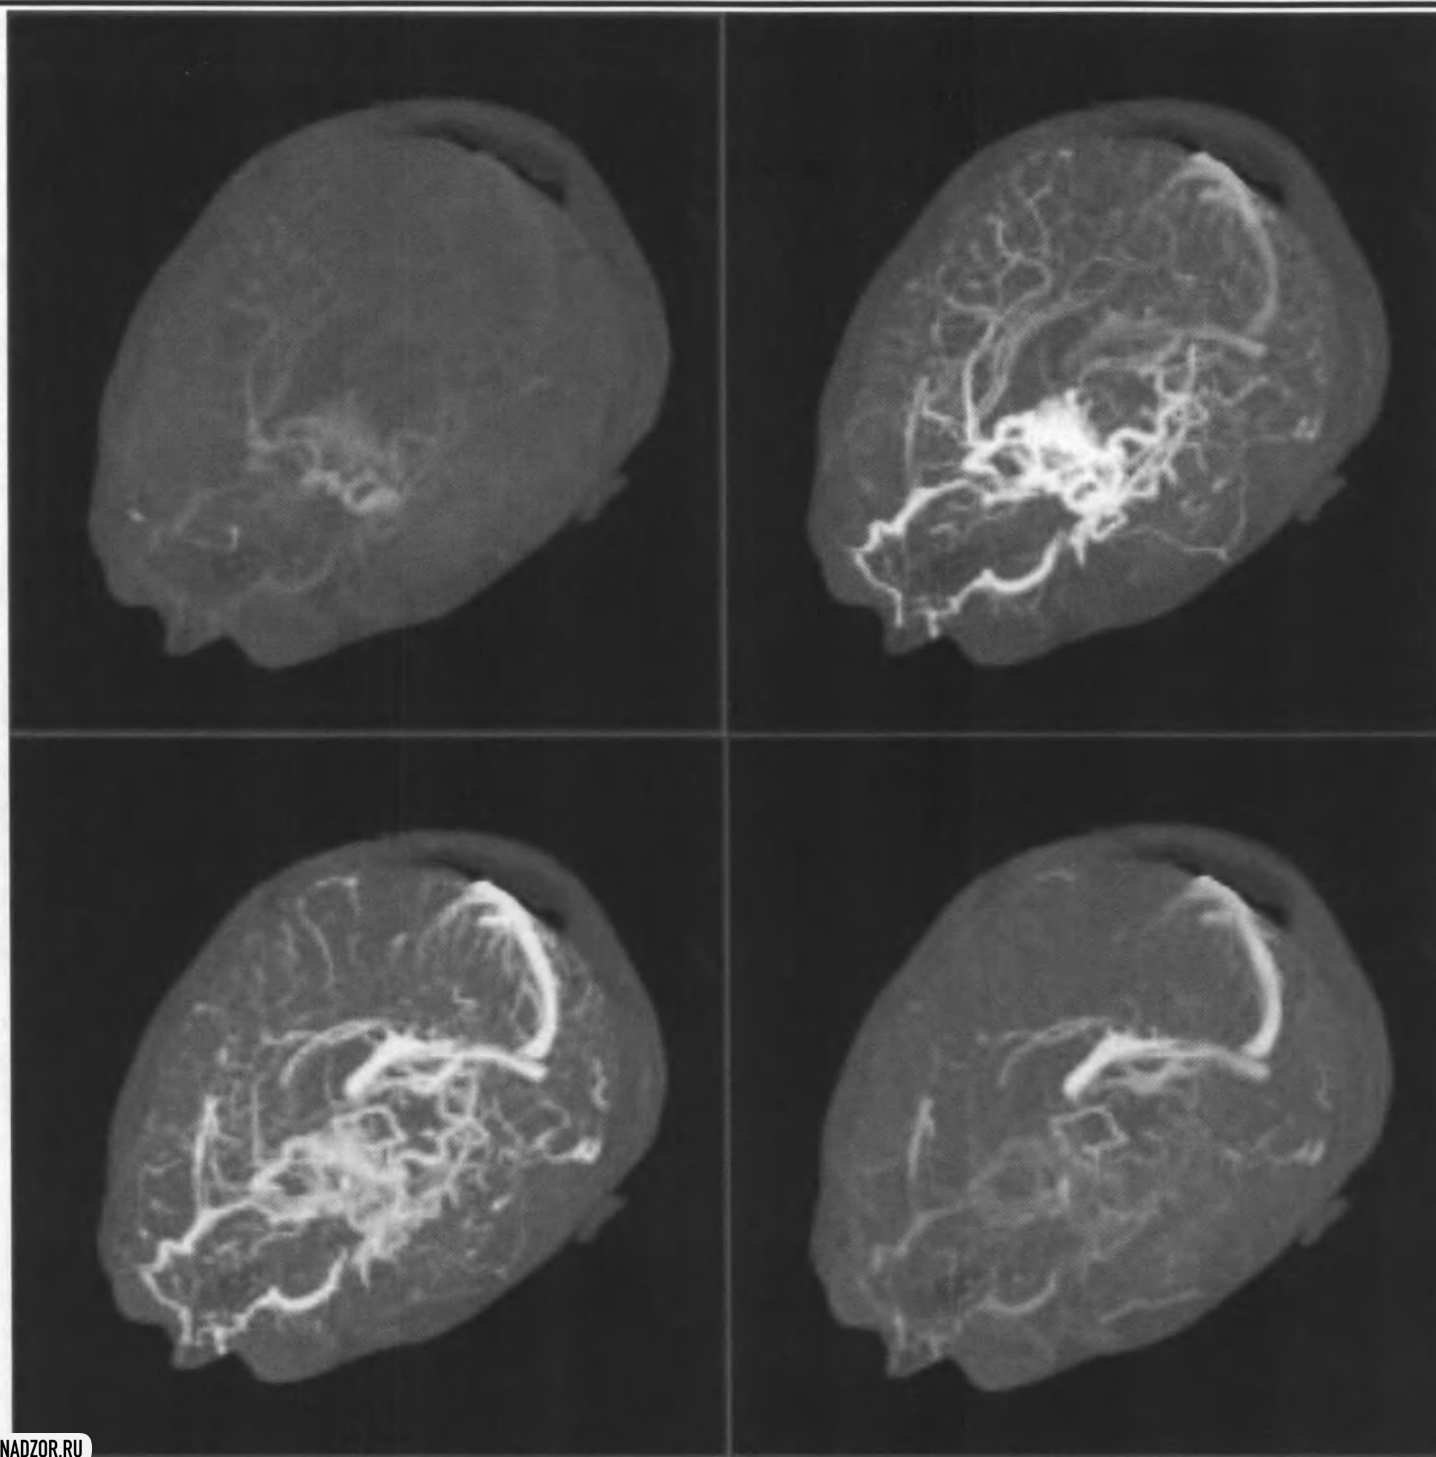


54. Программный пакет - интерфейс для подключения к системе на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

Schedule							
Patient Name	Patient ID	Accession #	Exam Description	Date ▲	Time ▲	Now ▼	Idiographic Patient
	all				11:31 AM	N	
HAGEN, PAUL ERIC	GEHC-379-06-1961	7139-72074-73617	DOUBLE HELIX	12-01-2013	06:00 AM	N	
GARRIOTT, BARBE...	GEHC-379-06-2549	1006-30900-22290	ABOPEL	12-01-2013	06:30 AM	N	
FLOWERS, ABE JAN...	GEHC-400-11-7277	4233-19841-80398	NECK	12-01-2013	06:00 AM	N	
PETERS, RAE SAM	GEHC-771-88-4233	1347-30799-74621	ROUTINE HEAD	12-01-2013	06:30 AM	N	
CASILLAS, IRELAN...	GEHC-080-14-2298	0670-74540-00080	SELLA SUPINE	12-01-2013	07:00 AM	N	
FORD, MYER HOPE	GEHC-524-10-9086	1310-67012-12502	CHEST/ABO PELVIS	12-01-2013	07:30 AM	N	
HIGA, YOSHII CAR...	GEHC-731-04-4851	0314-18067-40097	SHOULDER	12-01-2013	08:00 AM	N	
ELLIS, FORD ALICE	GEHC-773-77-3301	8996-34865-26202	AORTIC DISSECTION	12-01-2013	08:30 AM	N	
HEILEMAN, MINE...	GEHC-229-48-4483	5156-92903-23079	ROUTINE HEAD	12-01-2013	09:00 AM	N	
DALEY, NASH MIT...	GEHC-473-00-5887	5006-07398-10639	C-SPINE	12-01-2013	09:30 AM	N	
SANDERS, HASHI...	GEHC-861-40-4159	3812-95075-48639	ROUTINE HEAD	12-01-2013	10:00 AM	N	
SULLIVAN, ROBER...	111-222-333	405	PELVIS	12-01-2013	10:00 AM	N	
SULLIVAN, ROBER...	111-222-333	403	CHEST	12-01-2013	10:00 AM	N	
SULLIVAN, ROBER...	111-222-333	404	ABDOMEN	12-01-2013	10:00 AM	N	
HAYDEN, PARK ED...	333-444-555	502	ROUTINE CHEST W/ CO.	12-01-2013	10:00 AM	N	
BROWNELL, METZ ...	555-666-777	506	CT HEAD W/CONTRAST L	12-01-2013	10:00 AM	N	
MANNING, CESZY...	777-888-999	510	TEMPORAL BONES	12-01-2013	10:00 AM	N	
WOODMAN, JORD...	GEHC-506-43-3725	2489-67297-36380	PEDICLE	12-01-2013	10:30 AM	N	
MEREDITH, LEHM...	GEHC-836-70-1387	3614-67211-04141	PRIEPOST KIDNEY	12-01-2013	11:00 AM	N	
GLAZER, SCHNEID...	GEHC-230-12-1487	8669-11842-95019	PEDICLE	12-01-2013	11:30 AM	N	
GODDWIN, HUBB...	GEHC-794-73-8089	4759-34009-38308	PELVIC FX	12-01-2013	12:00 PM	N	
SHIMIZU, DEPALM...	GEHC-316-80-1998	4742-94820-03446	PELVIS	12-01-2013	12:30 PM	N	
SAKURAI, TAKAM...	GEHC-117-80-0955	9969-77514-42151	RTN HEAD FEET FIRST	12-01-2013	01:00 PM	N	
PLEASE TO WHATEVER	GEHC-379-06-1961	7139-72074-73617	RT HEAD W/...	12-01-2013	01:30 PM	N	


55. Программный пакет для выполнения реконструкции ПЭТ изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

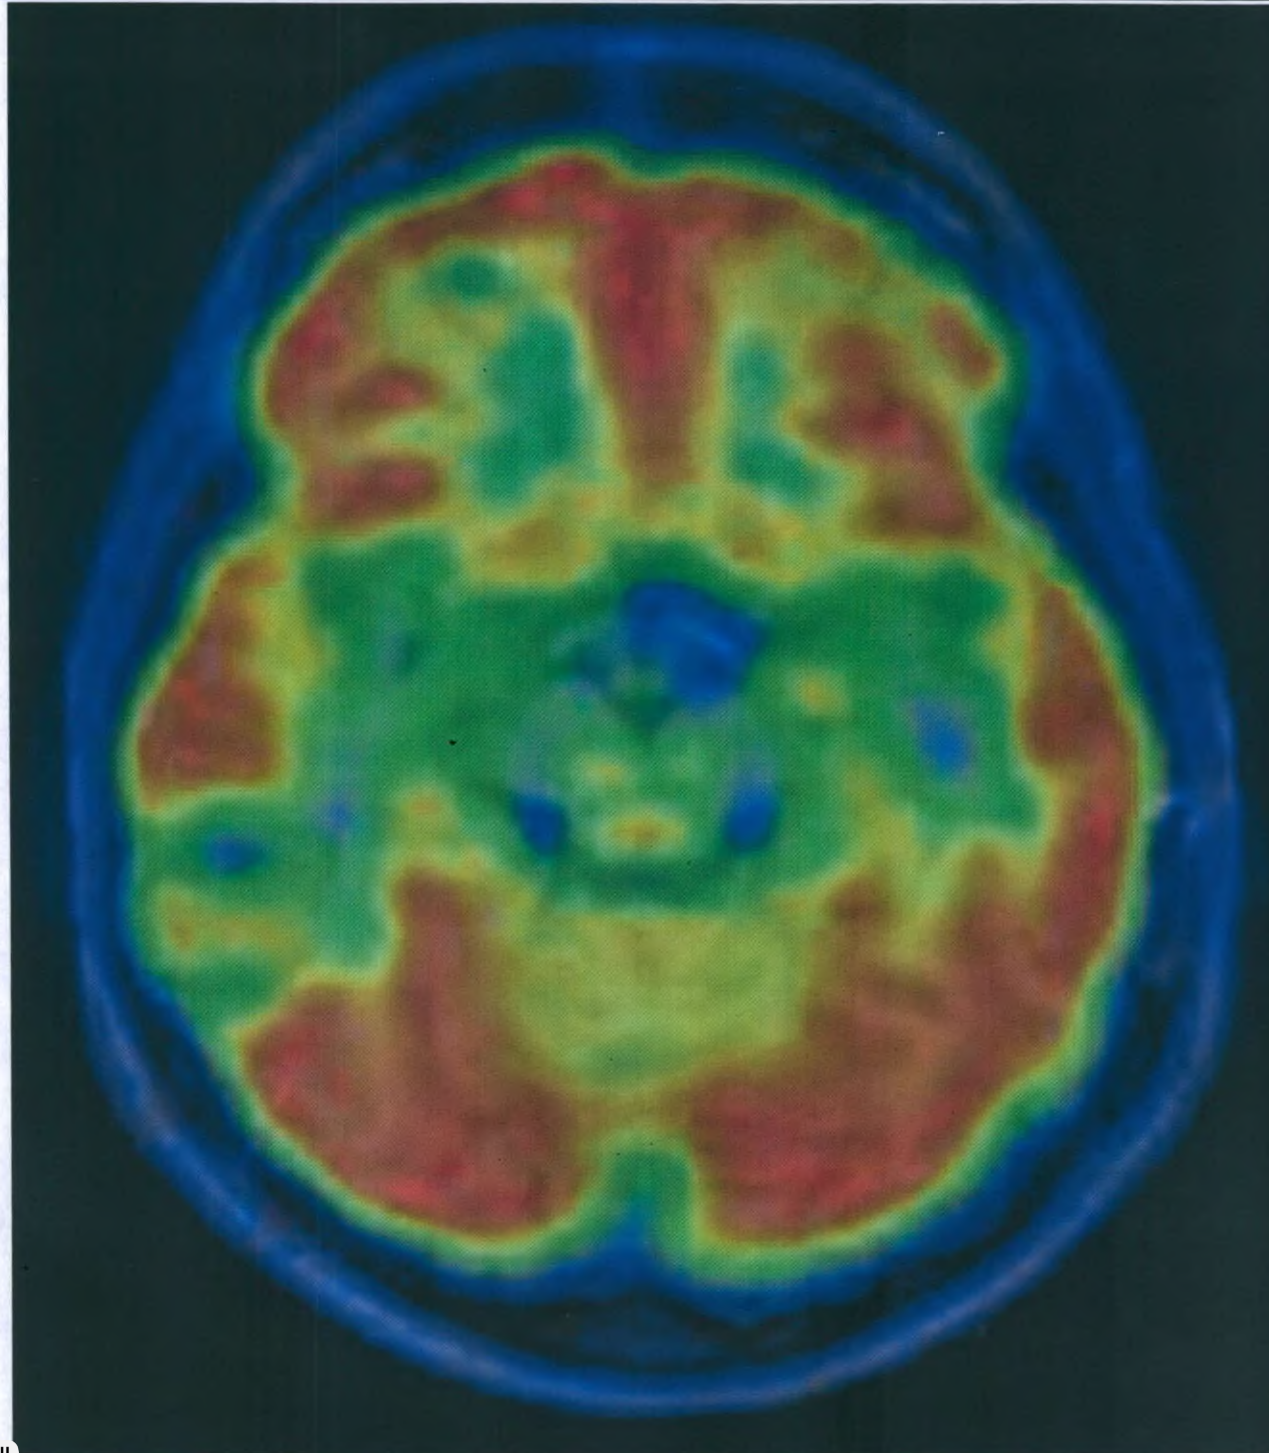


56. Программный пакет для выполнения реконструкции МРТ изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ 83 активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

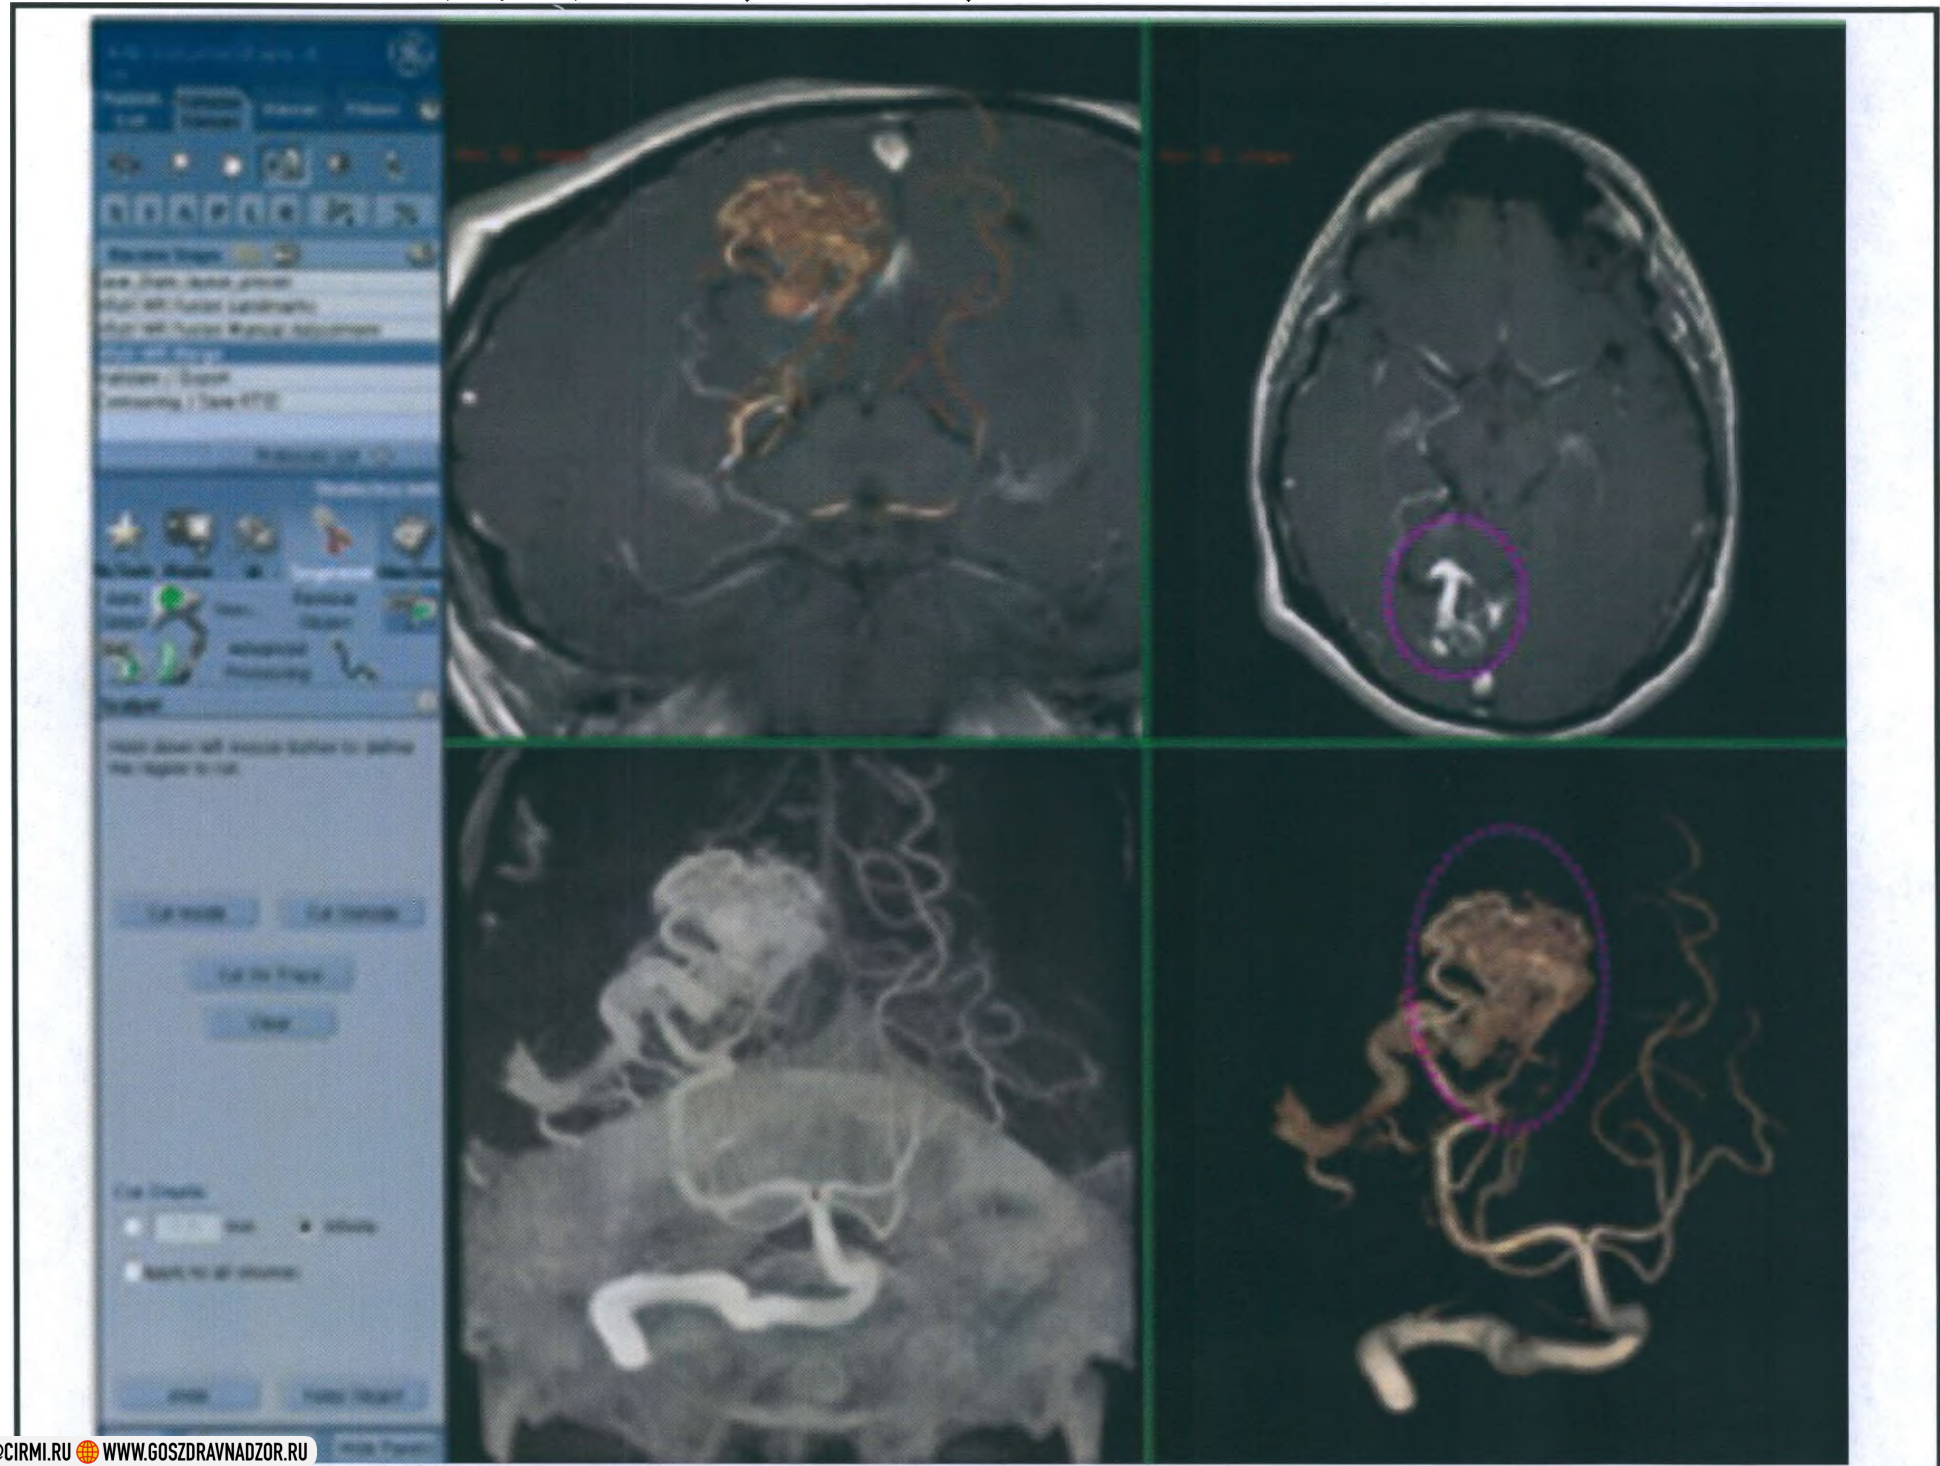

57. Программный пакет для совместного исследования изображений КТ и ПЭТ на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

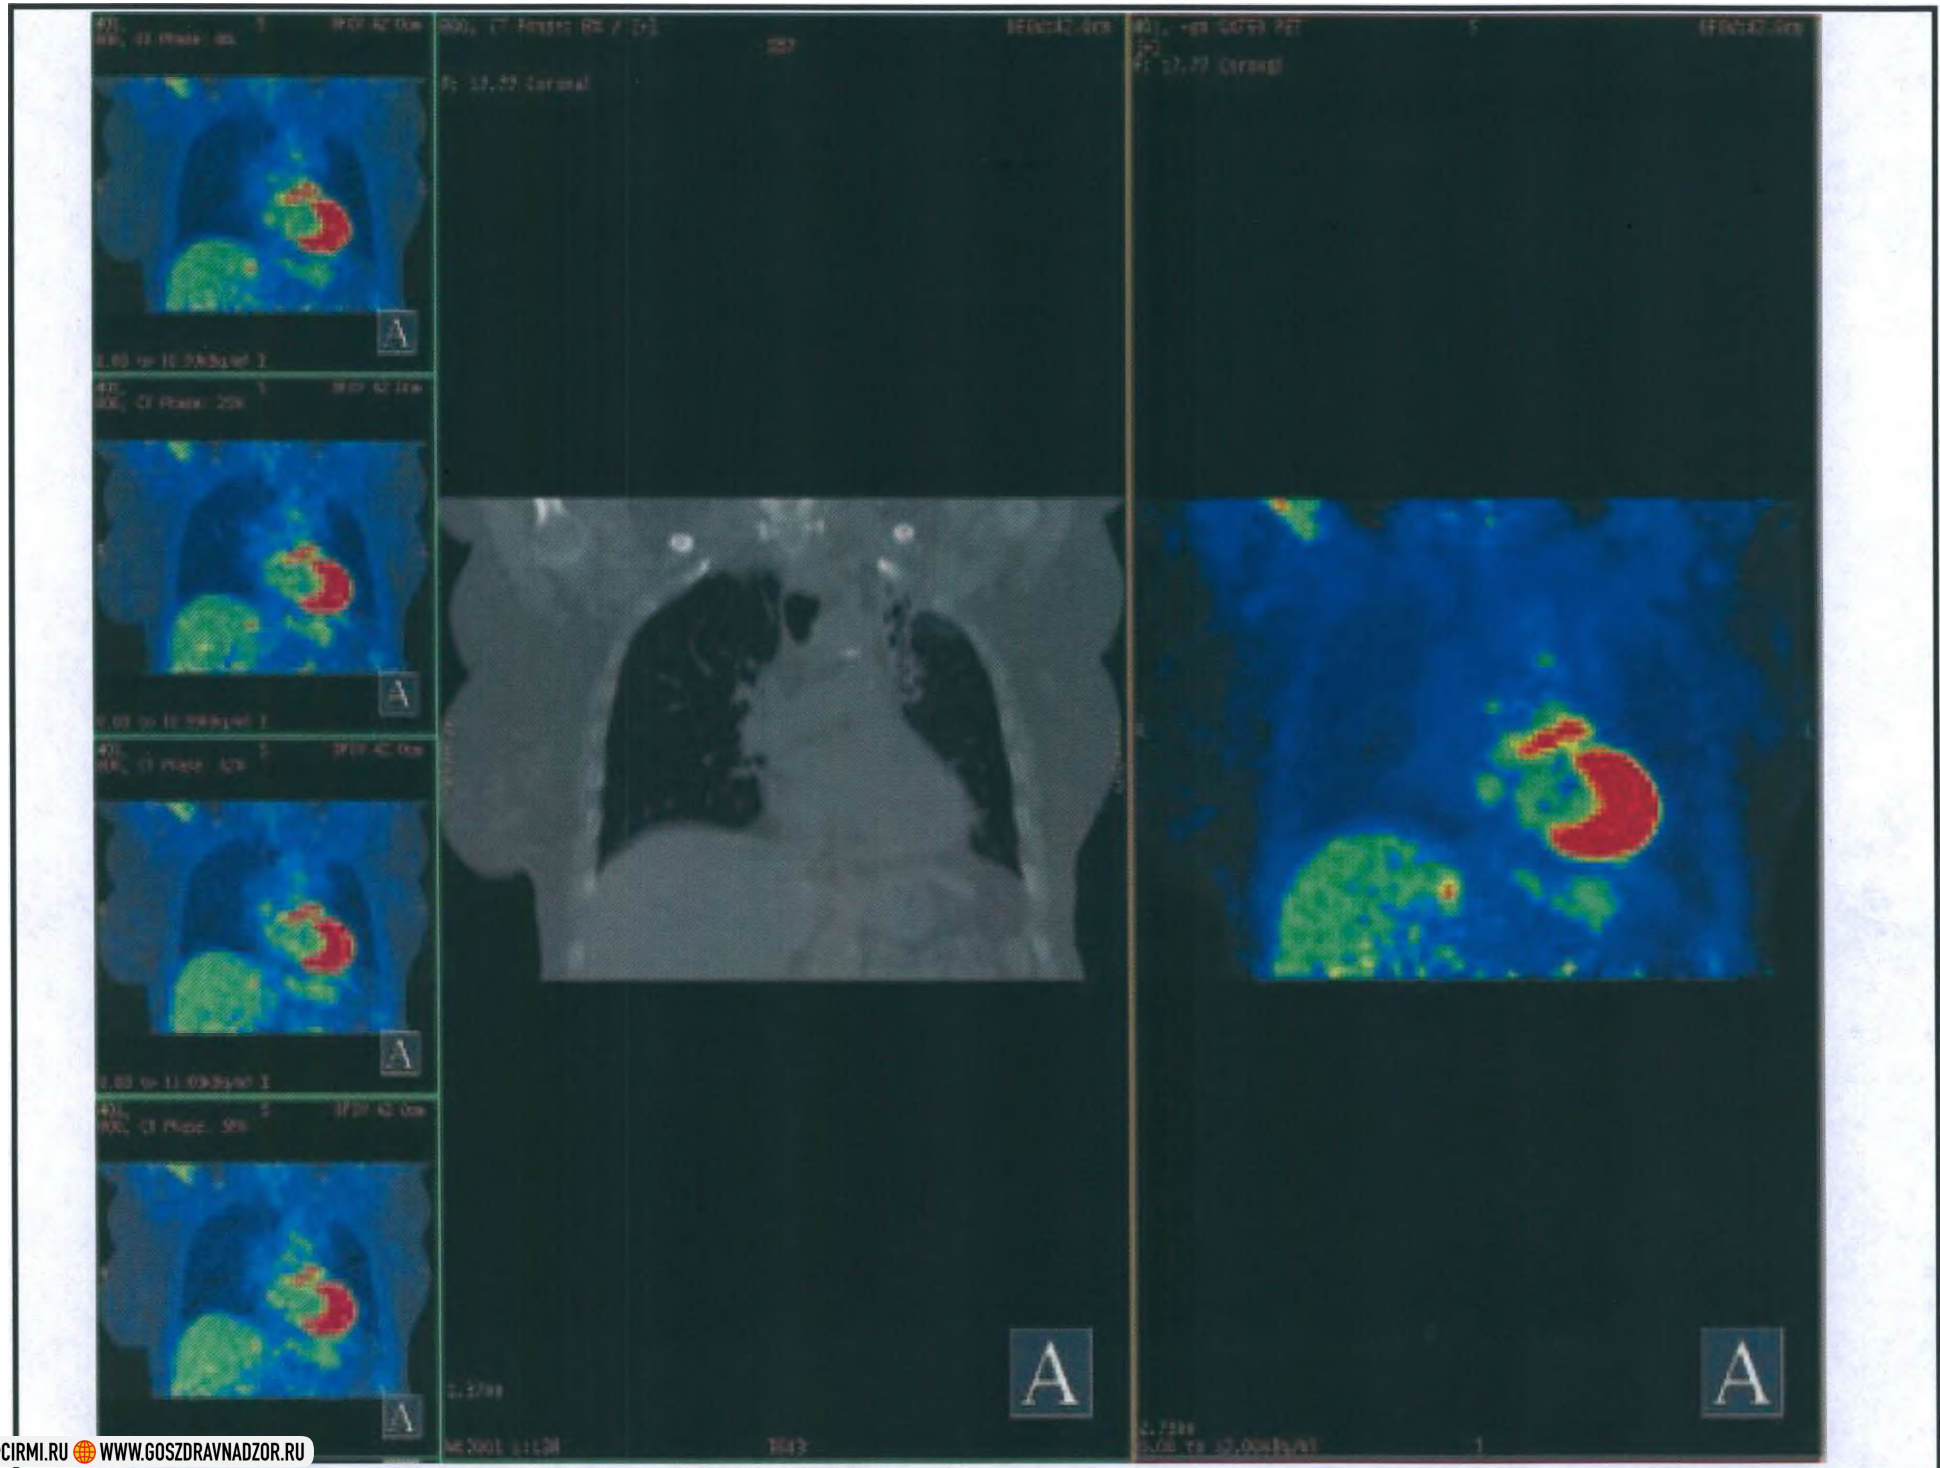

58. Программный пакет для совместного исследования изображений КТ и МРТ на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

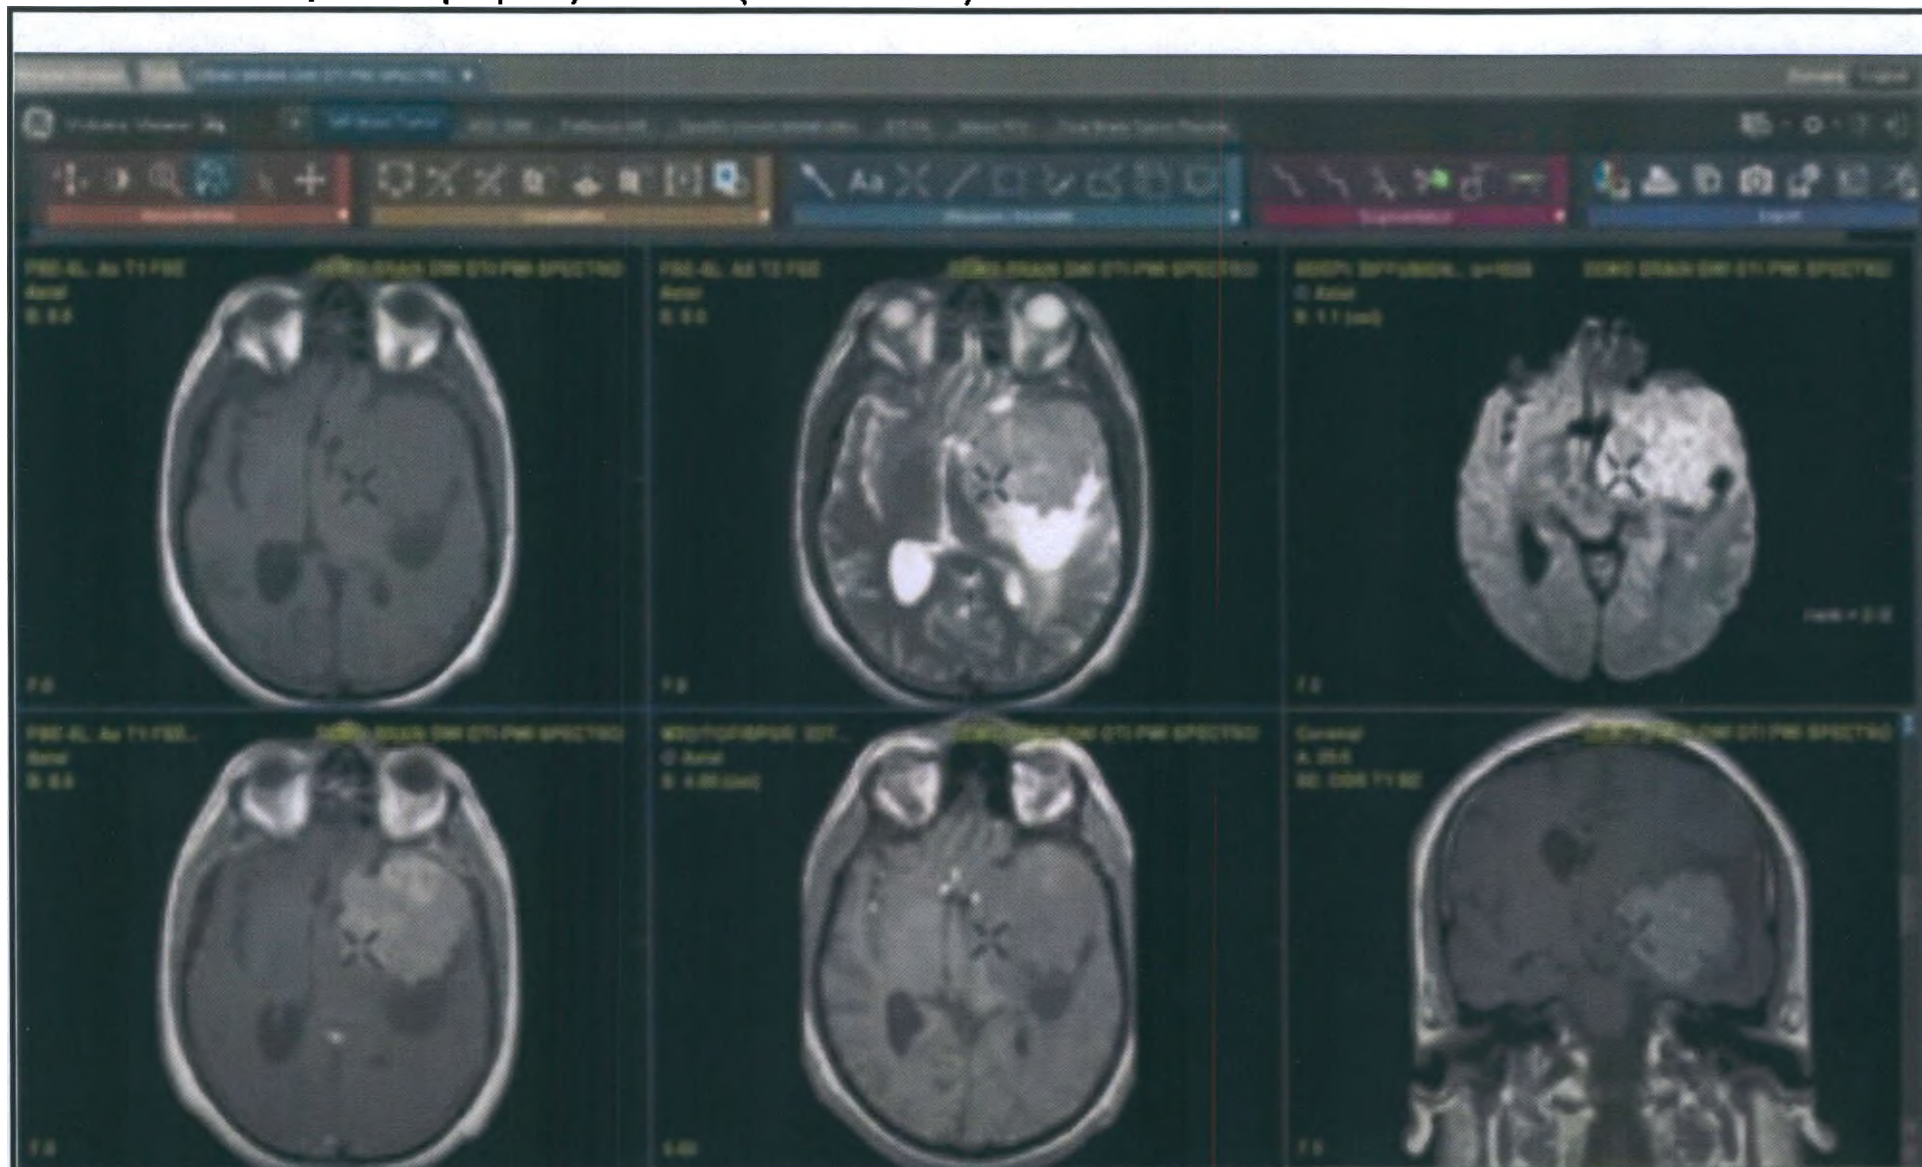


Finding 2 (Liver) - TARGET

Sep 11 2007 - CT 3




ROI 3
2Dmax: 13 mm

Oct 17 2007 - CT 3

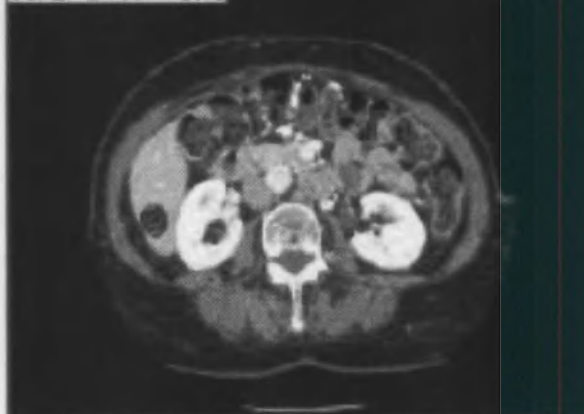

ROI 4
2Dmax: 17 mm (+31%)


Dec 27 2007 - CT 1

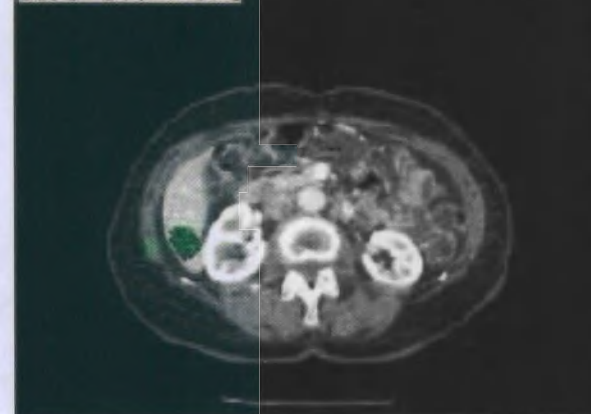

ROI 6
2Dmax: 22 mm (+69%)


Finding 1 (Liver) - TARGET

Sep 11 2007 - CT 3

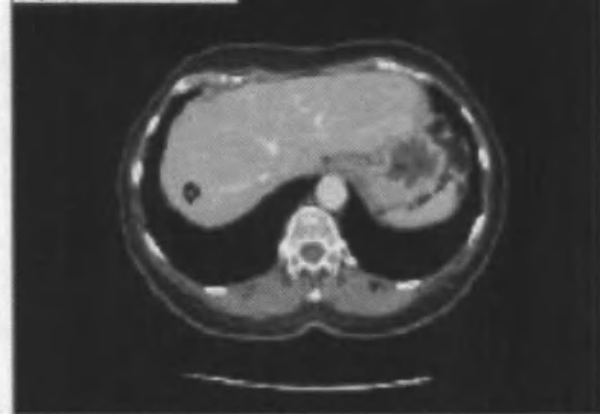

ROI 1
2Dmax: 10 mm

Oct 17 2007 - CT 3

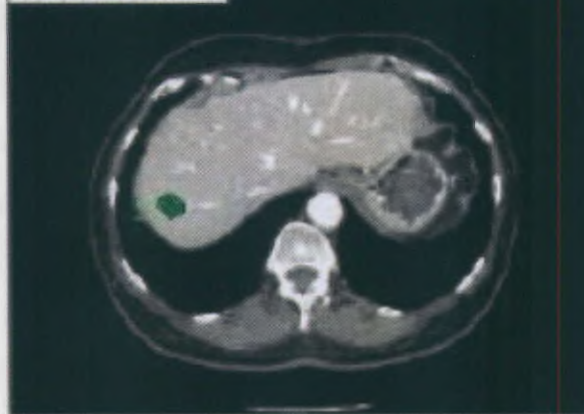

ROI 2
2Dmax: 15 mm (+50%)

Dec 27 2007 - CT 1



ROI 5
2Dmax: 16 mm (+60%)

SUMMARY - "RECIST 1.1"

	Sep 11 2007 (Ref) Baseline	Oct 17 2007	Dec 27 2007
Sum	23.0 mm	32.0 mm (+39%)	38.0 mm (+65%)
Lesion count	2 target lesion(s)	2 target lesion(s)	2 target lesion(s)

ECG & Gating

Auto Gating

 **Off**

Acquisition Window

... **Part 1**

 **50-60%, 400 mA**

... **Part 2**

 **=**

... **Part 3**

 **=**

HR Variation Allowance


0 BPM


Arrhythmia Retrigger

Off

Adaptive Gating

On

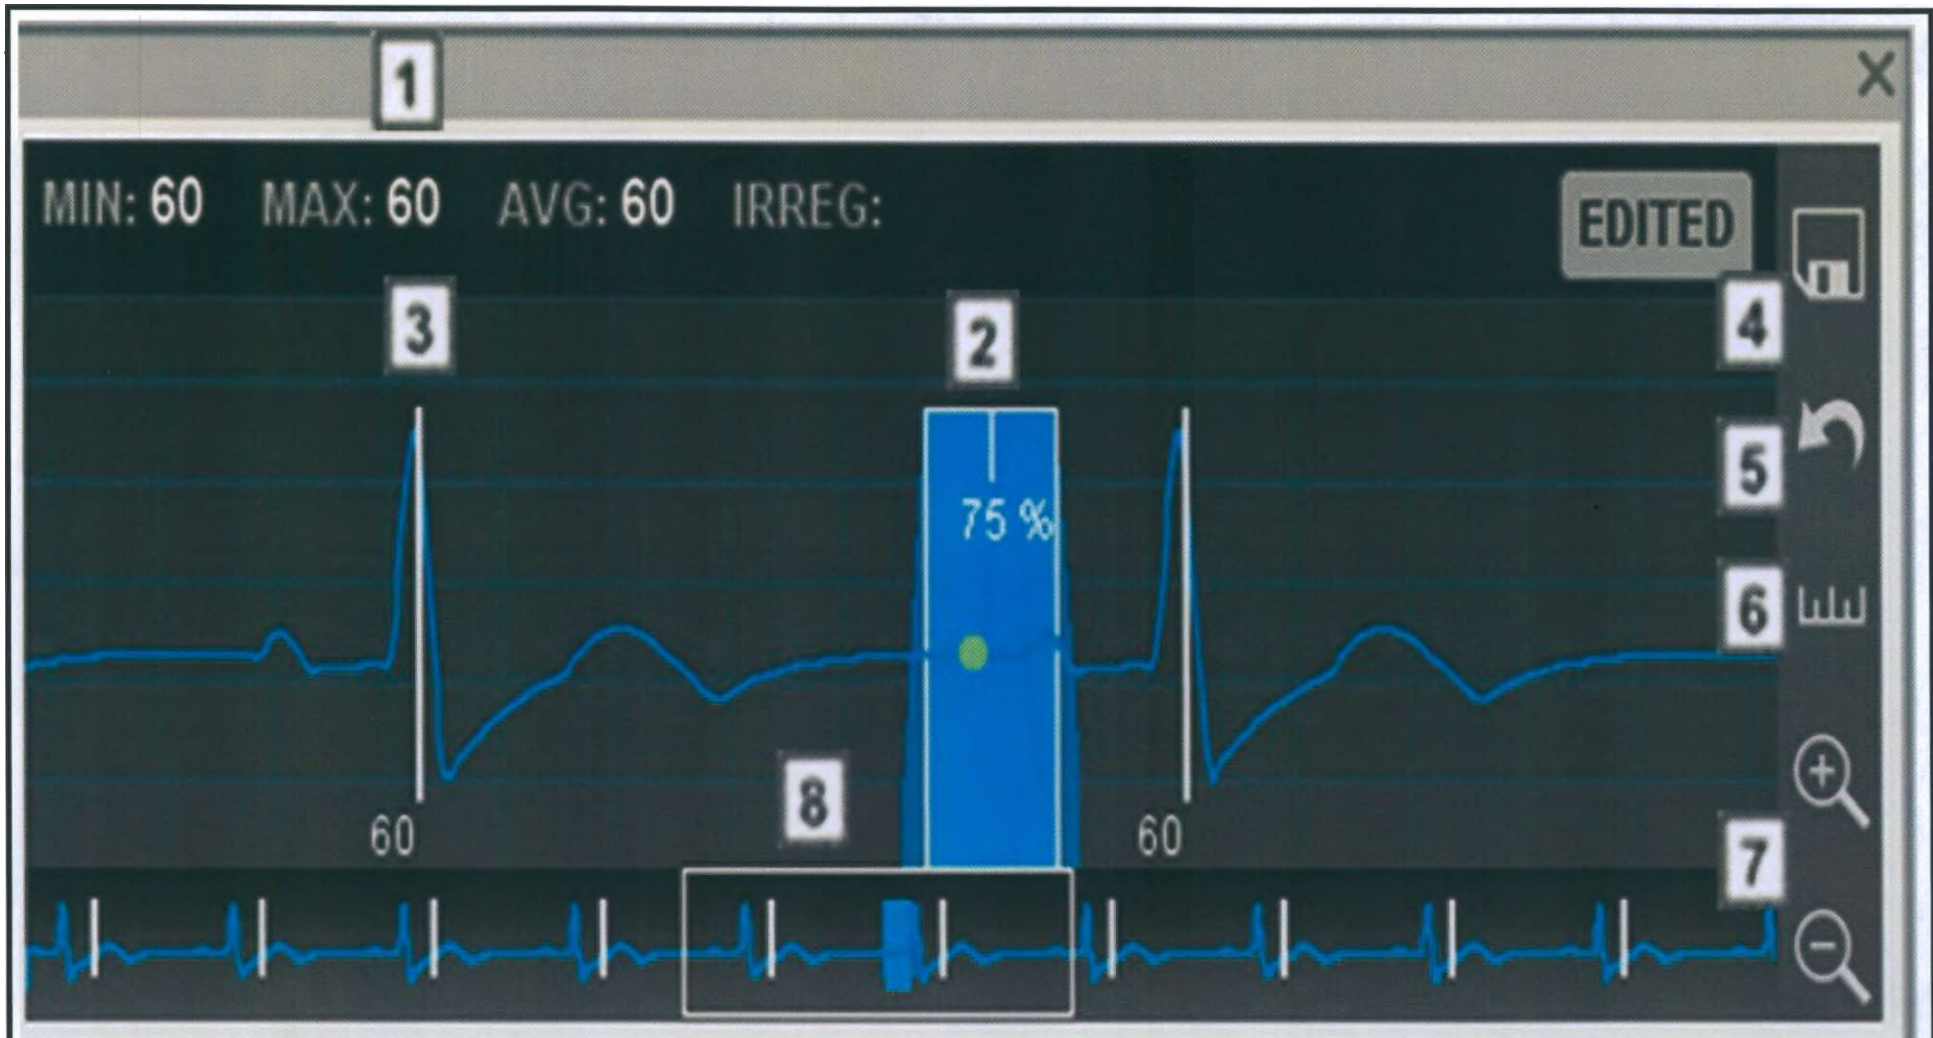

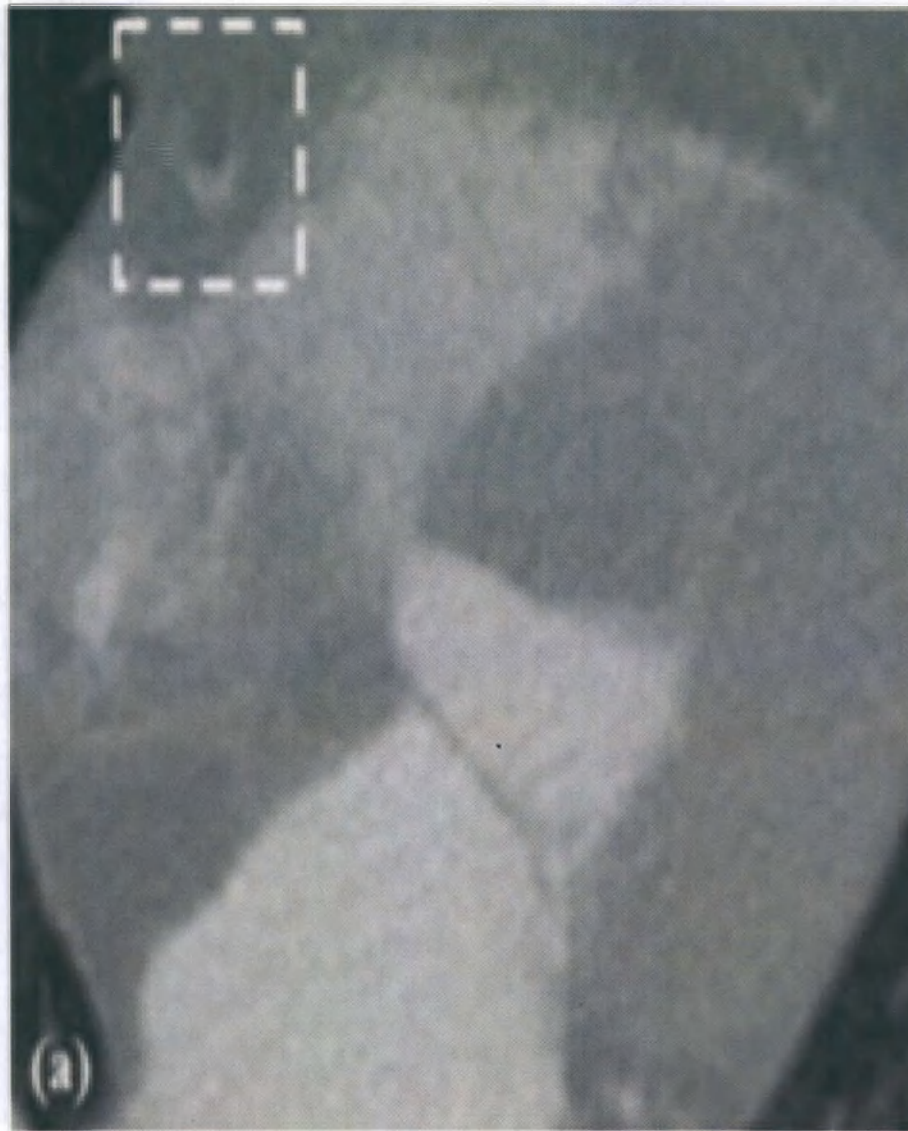


Standard end-systole - 44%




Smart Phase - 40%

63. Программное обеспечение для синхронизации с движением, дыханием, сердечным ритмом на оптических и/или электронных⁹⁰
и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 5 шт.).

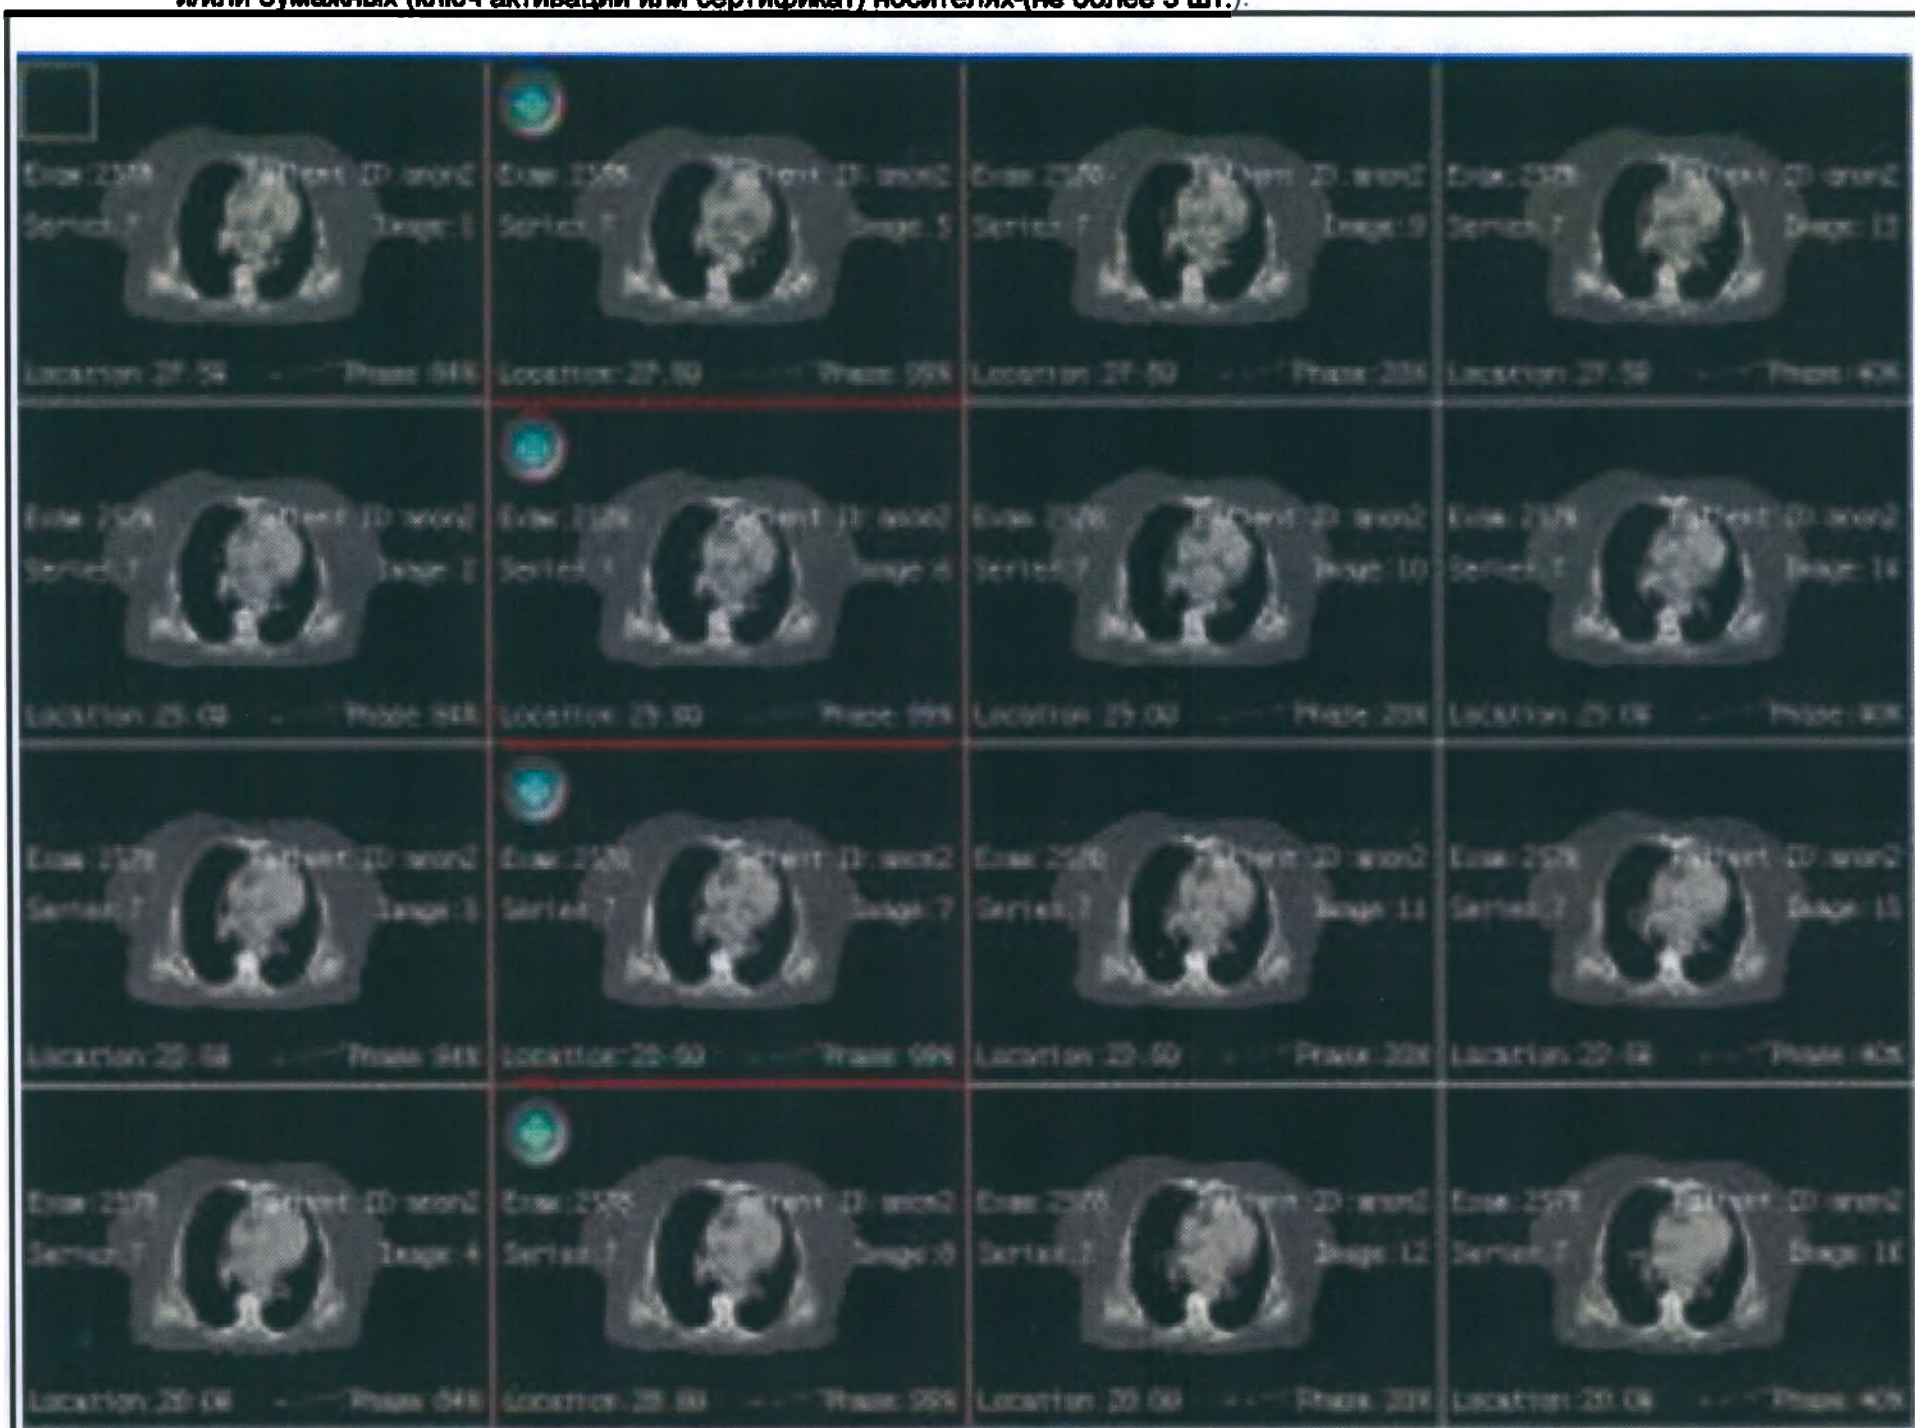

64. Программное обеспечение подсистемы маршрутизации потоков медицинских данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).⁹¹

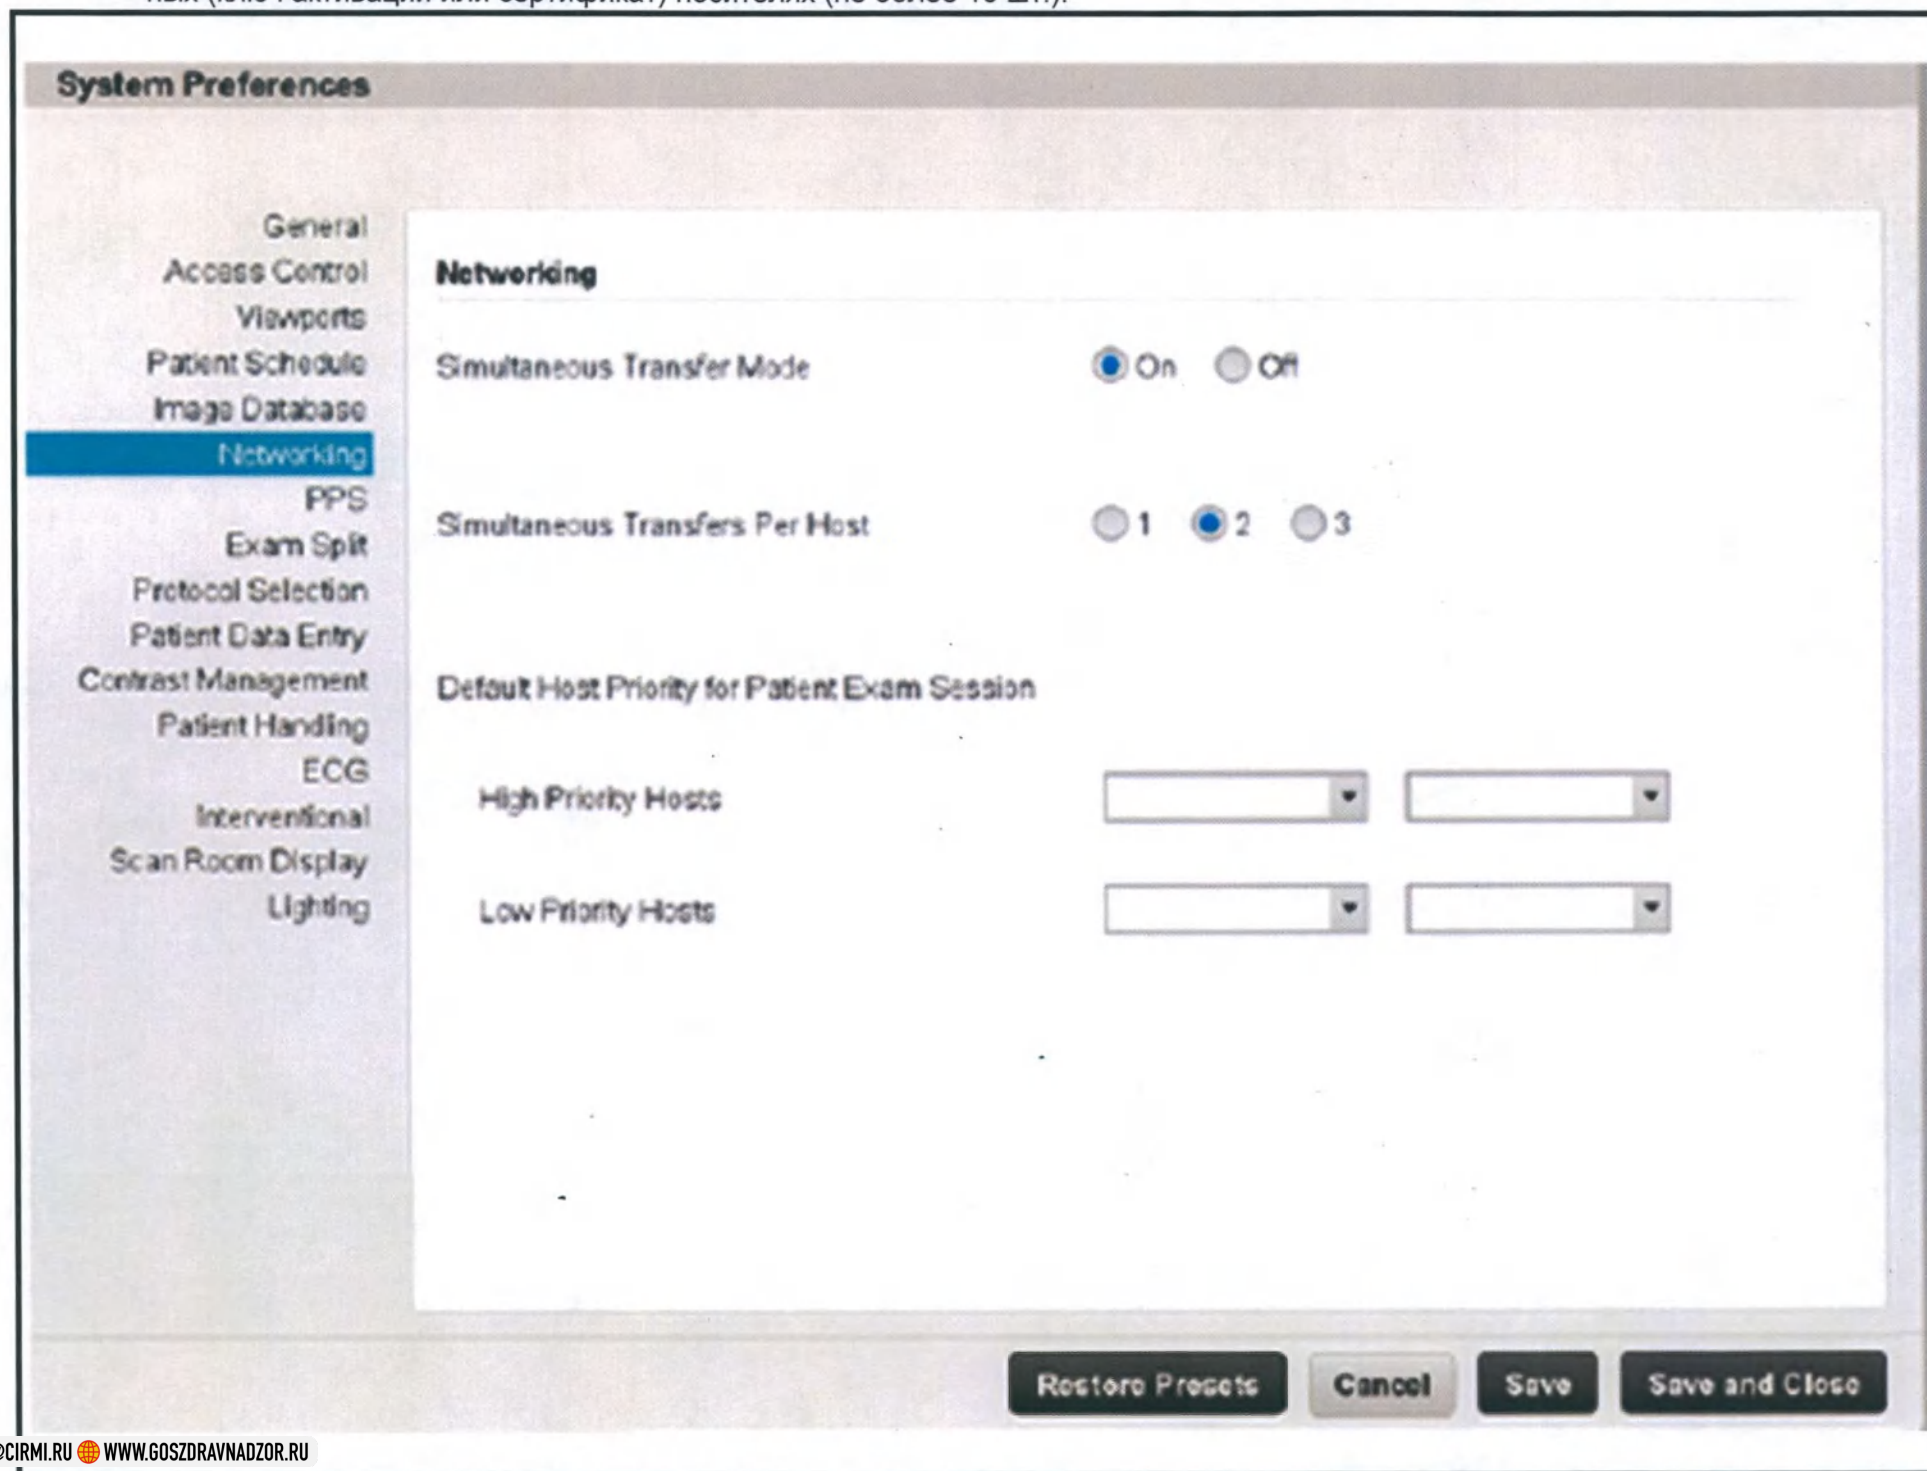

DOSE ALERT

A dose Alert Value will be exceeded!

The prescribed scan parameters result in a projected exam dose exceeding the user configured Alert Value. Select Cancel to go back to Viewedit and adjust scan parameters if clinically appropriate to set below the Alert Value. An authorized user name and password must be entered to select Confirm. Selecting Confirm will proceed to scan and log user confirmation of scan parameters exceeding the Alert Value.

	AV	Projected/Accumulated	Start	End
CTDIvol (mGy)	10.0	25.630	18.744	513L229

*Required Field:

*Ligon Name:

*Password:


*Diagnostic reason:

Cancel



Confirm


66. Устройство для расчета уровня лучевой нагрузки DoseWatch на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 3 шт.).

Series Dose Information		
Mean DLP 481.70 mGy.cm Mean CTD _{ref} 11.67 mGy n = 86	Mean DLP for past 3 months 241.10 mGy.cm Mean CTD _{ref} 5.90 mGy n = 3	Reference value -- mGy.cm Mean CTD _{ref} -- mGy
Study Dose Information		
Mean DLP 817.19 mGy.cm 3 ACQ n = 51	Mean DLP for past 3 months 743.32 mGy.cm 5 ACQ n = 1	Reference value -- mGy.cm -- ACQ
Protocol Information		
Protocol	Mean DLP (mGy.cm)	Number of Studies
19724040	755.80	15
22688275	862.00	3

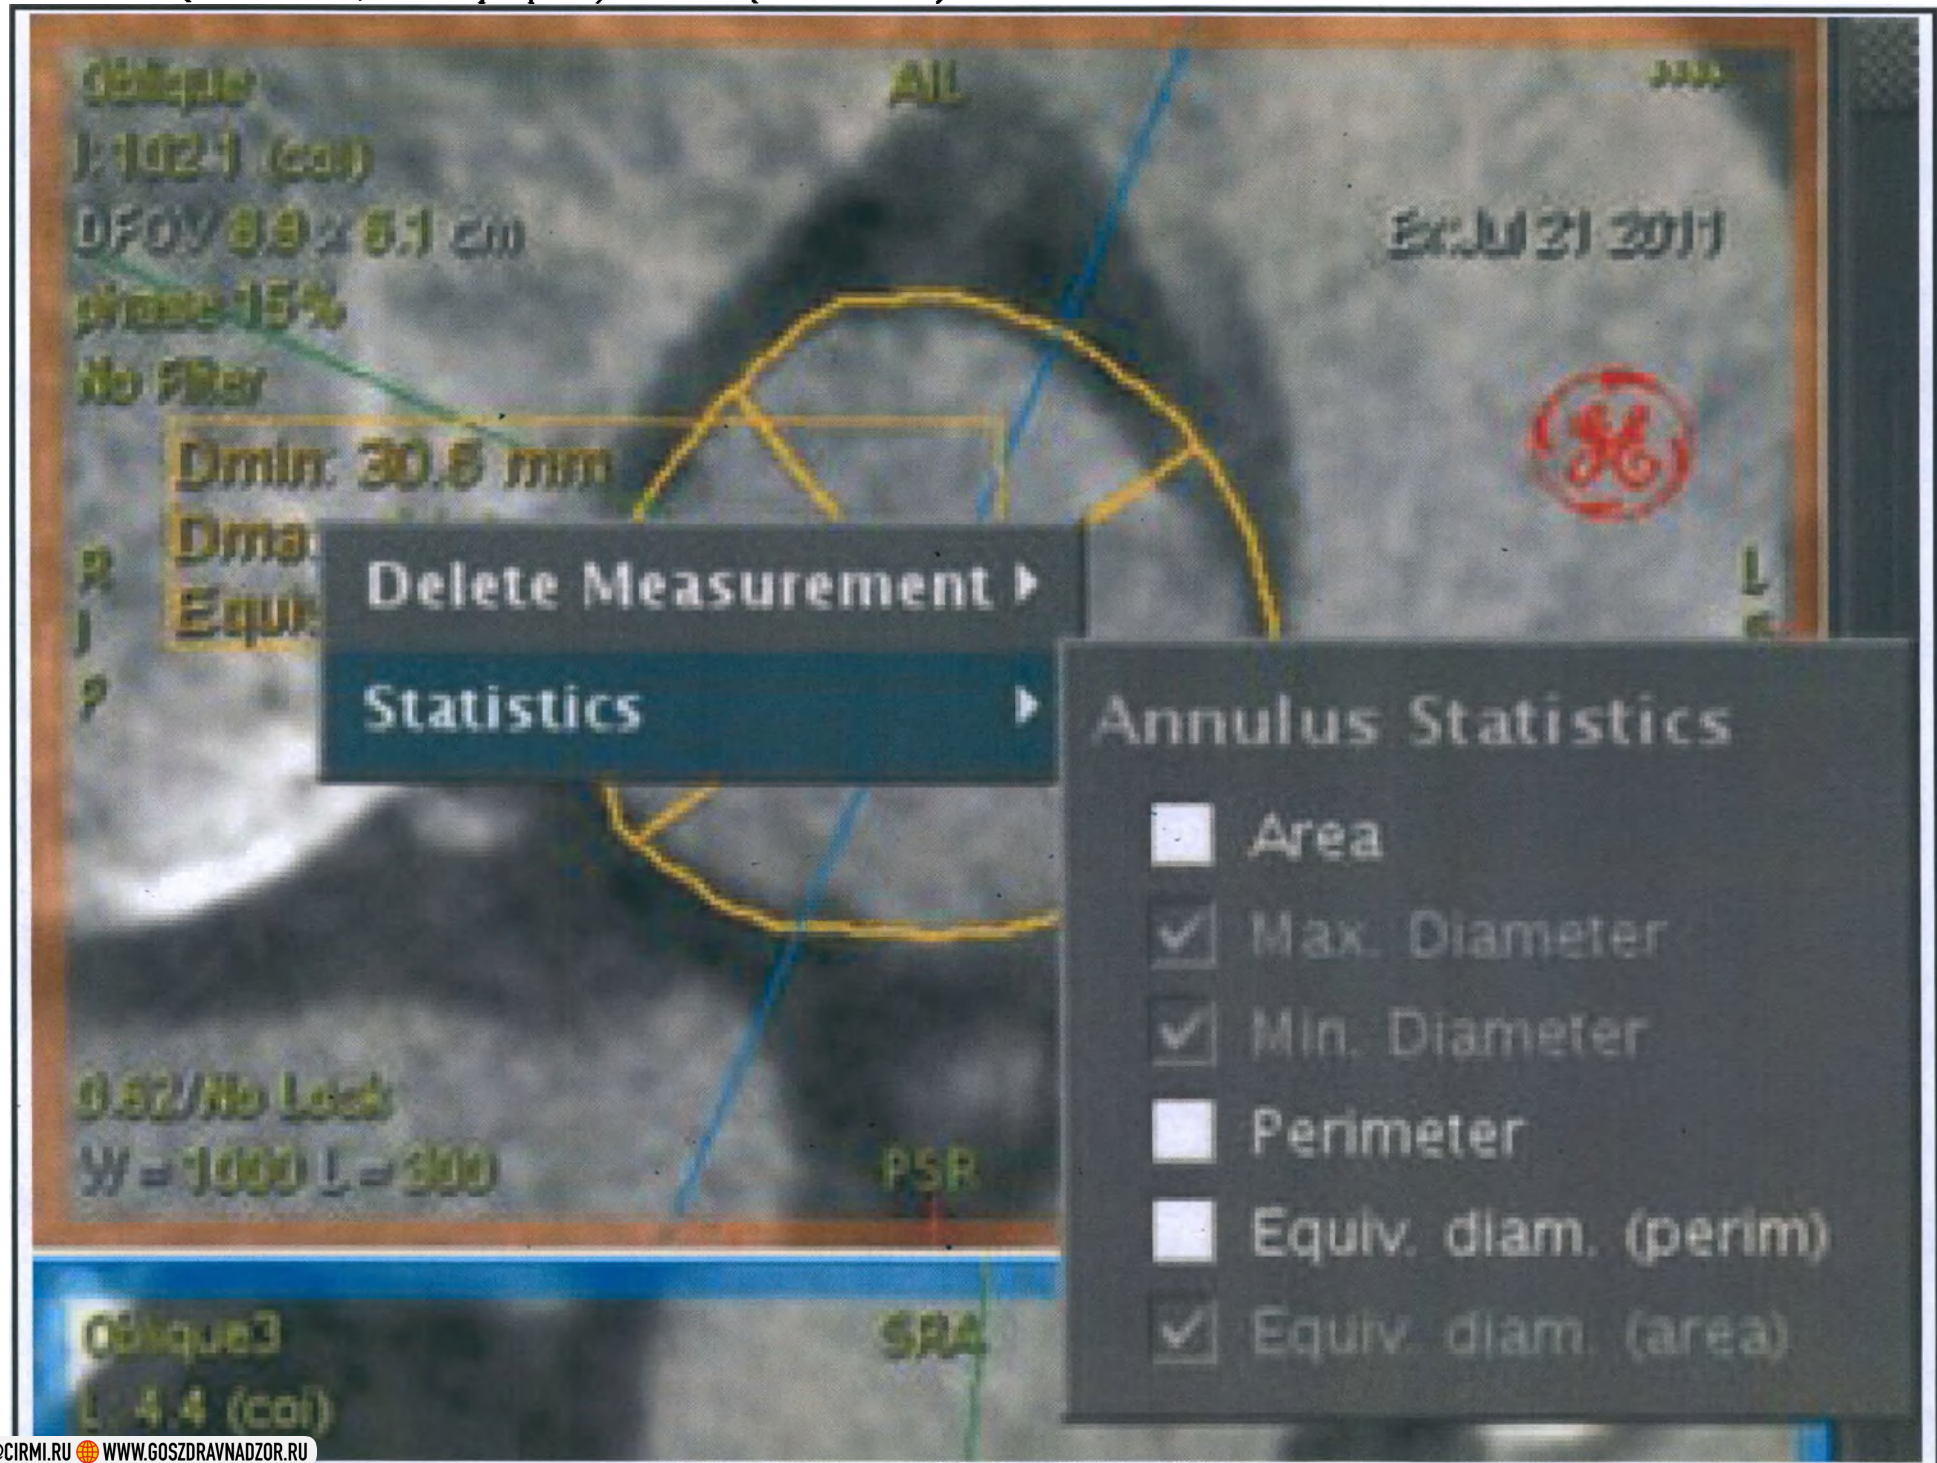


68. Программный пакет для оценки анатомии печени на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 5 шт.).

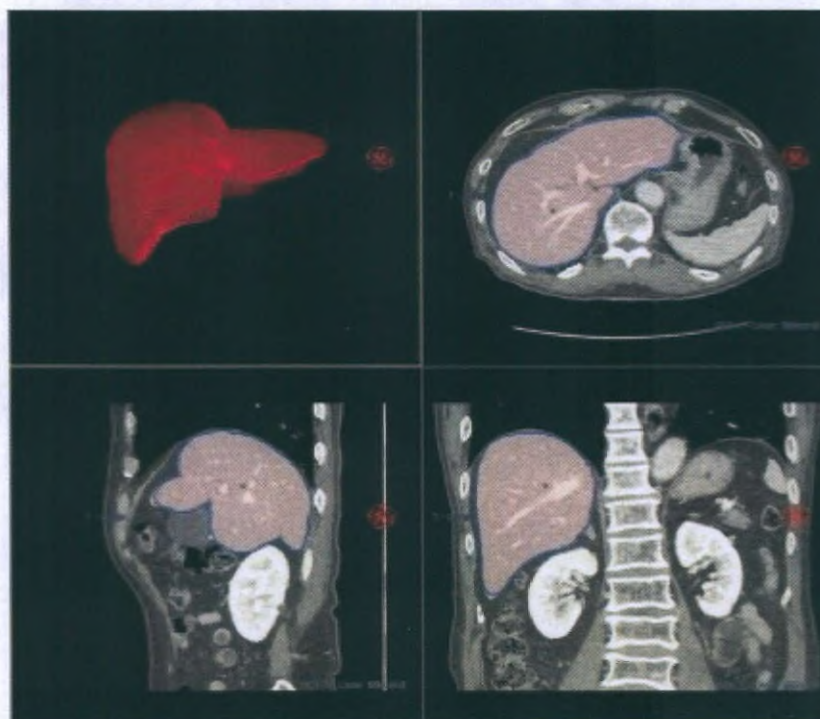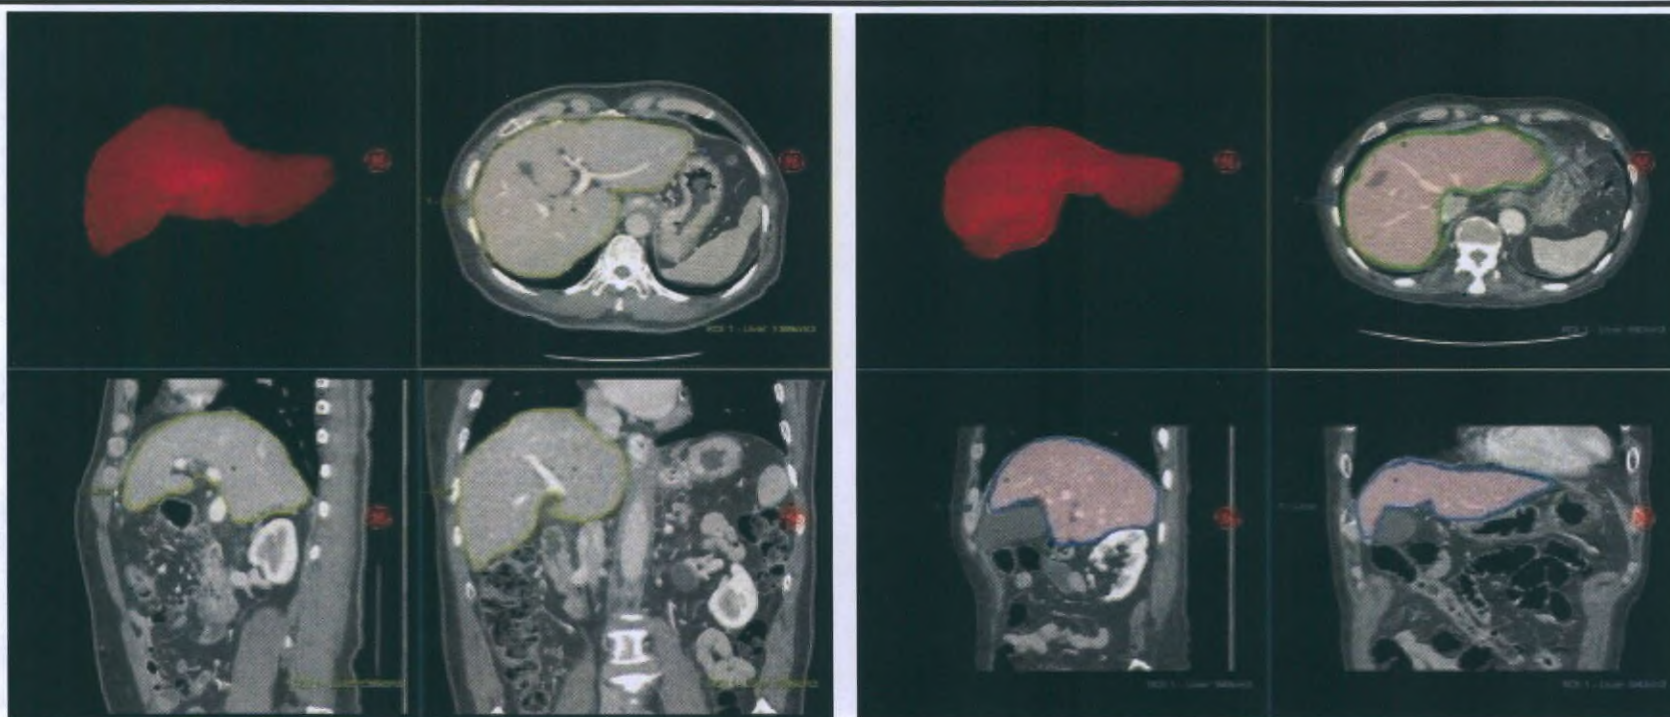

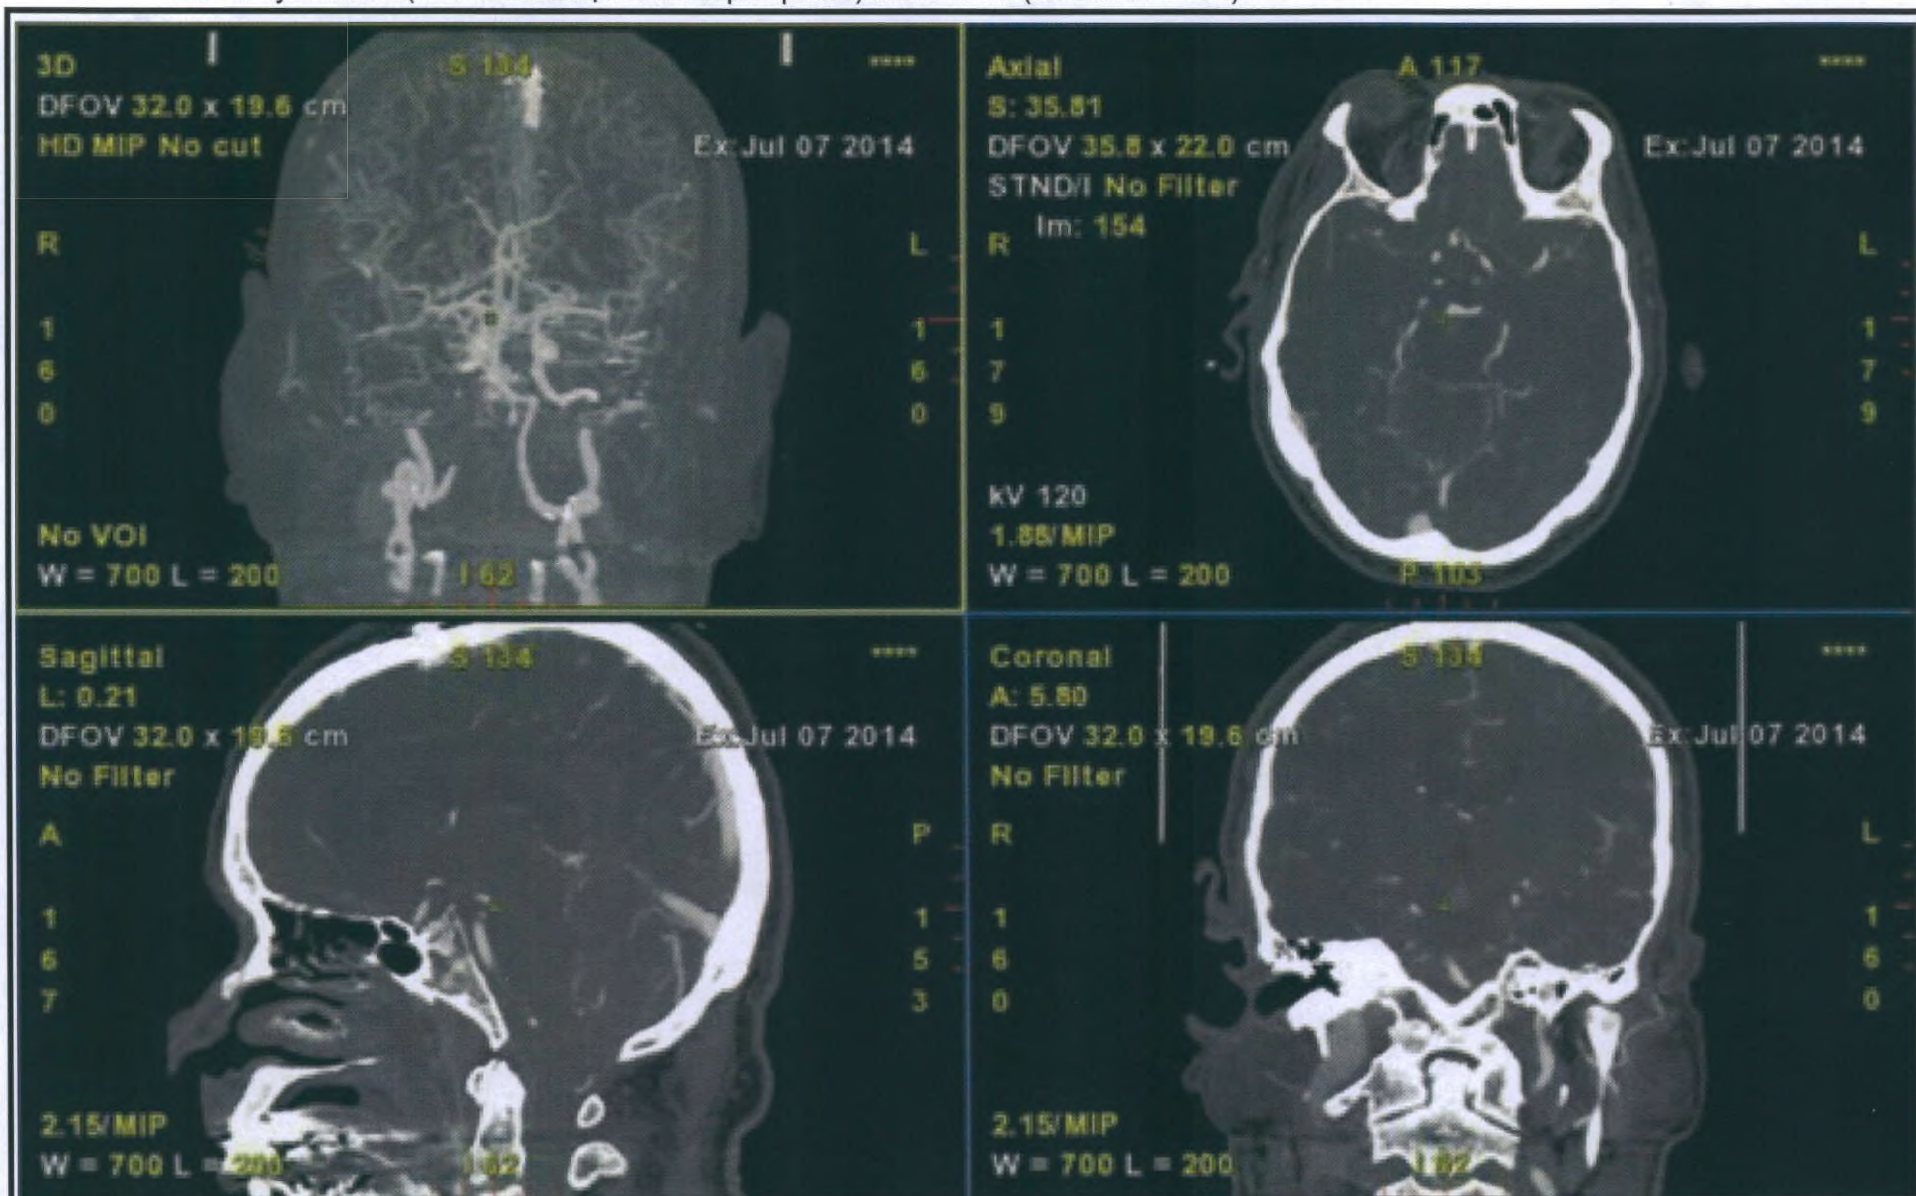


70.—Программный пакет для оценки инсультов на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат)⁹⁷
носителях (не более 5 шт.).

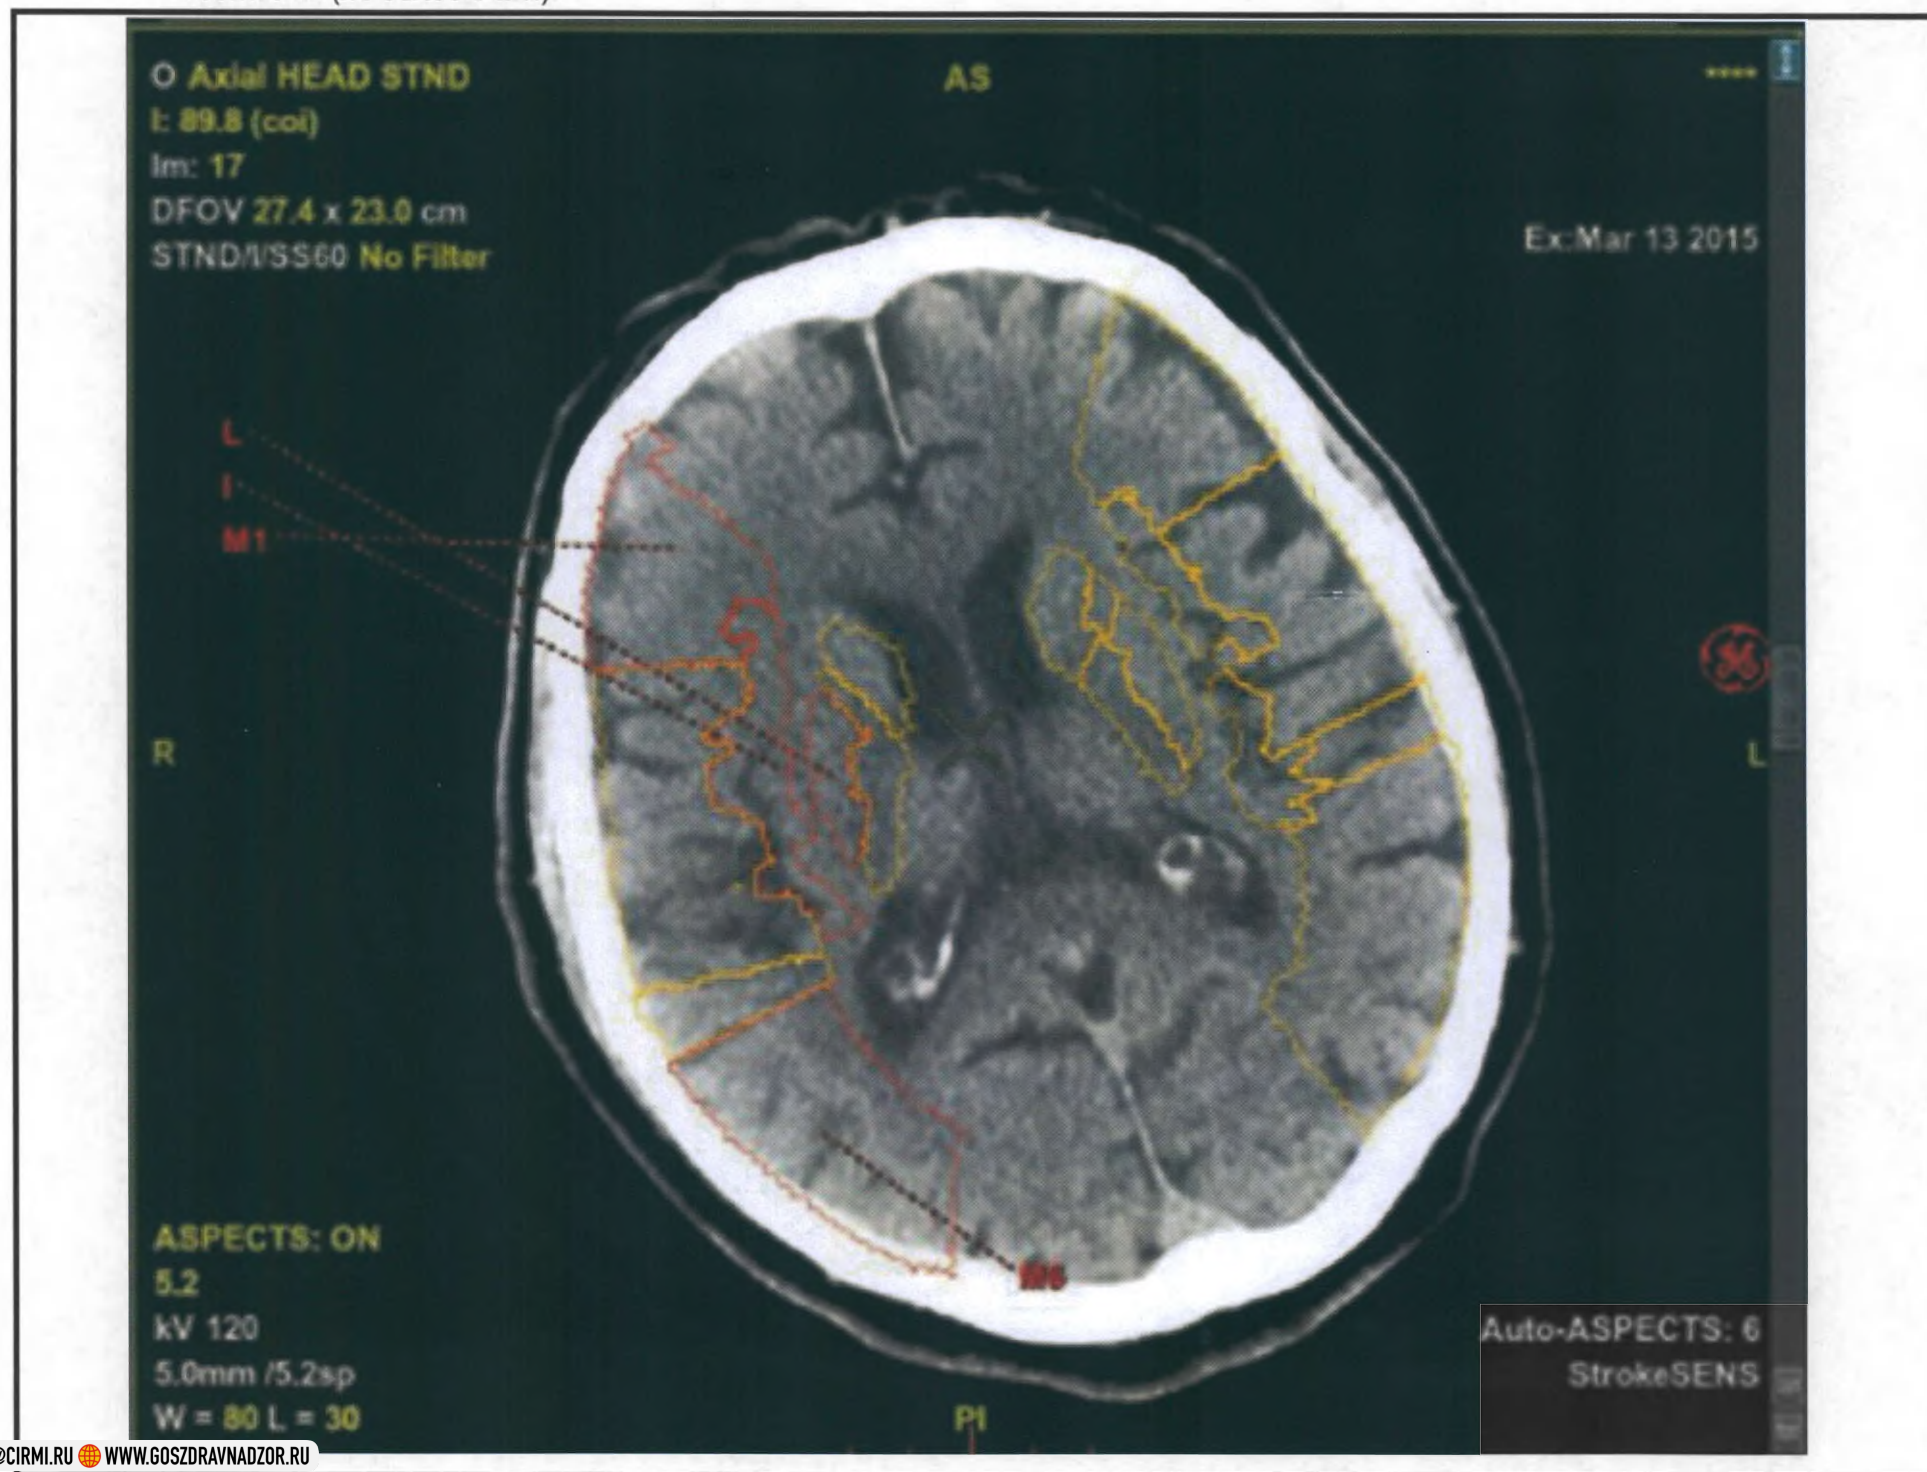




72. Основной аппаратный модуль рабочей станции врача (не более 10 шт.).

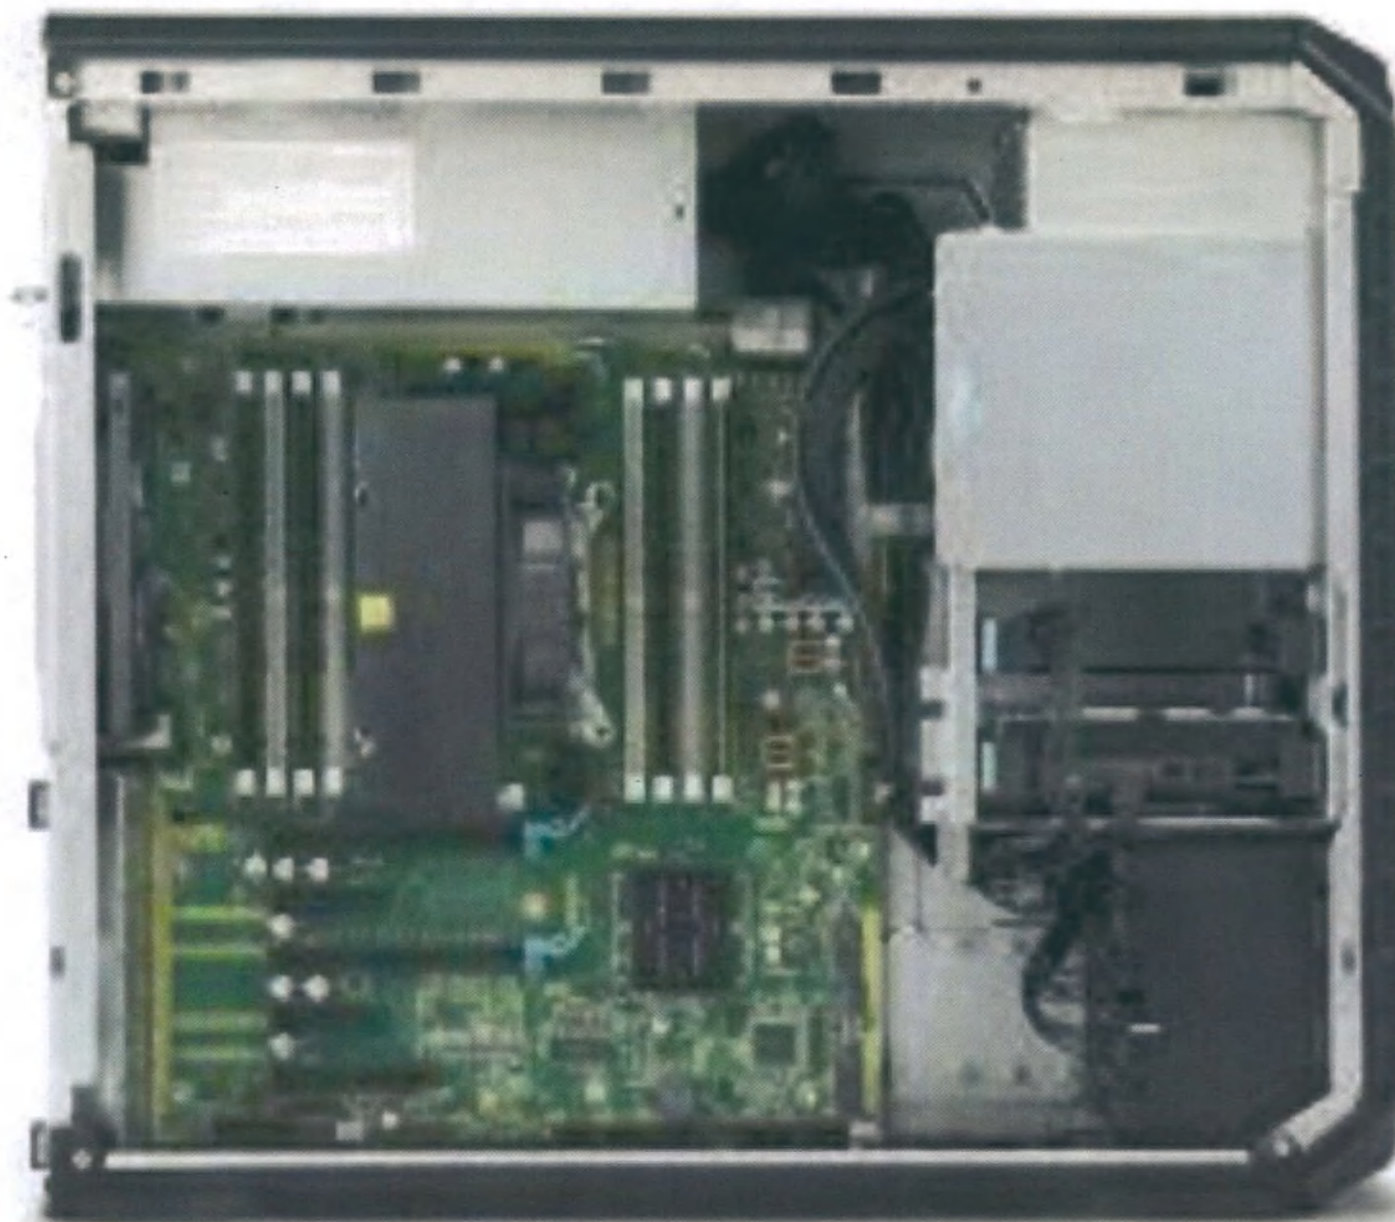



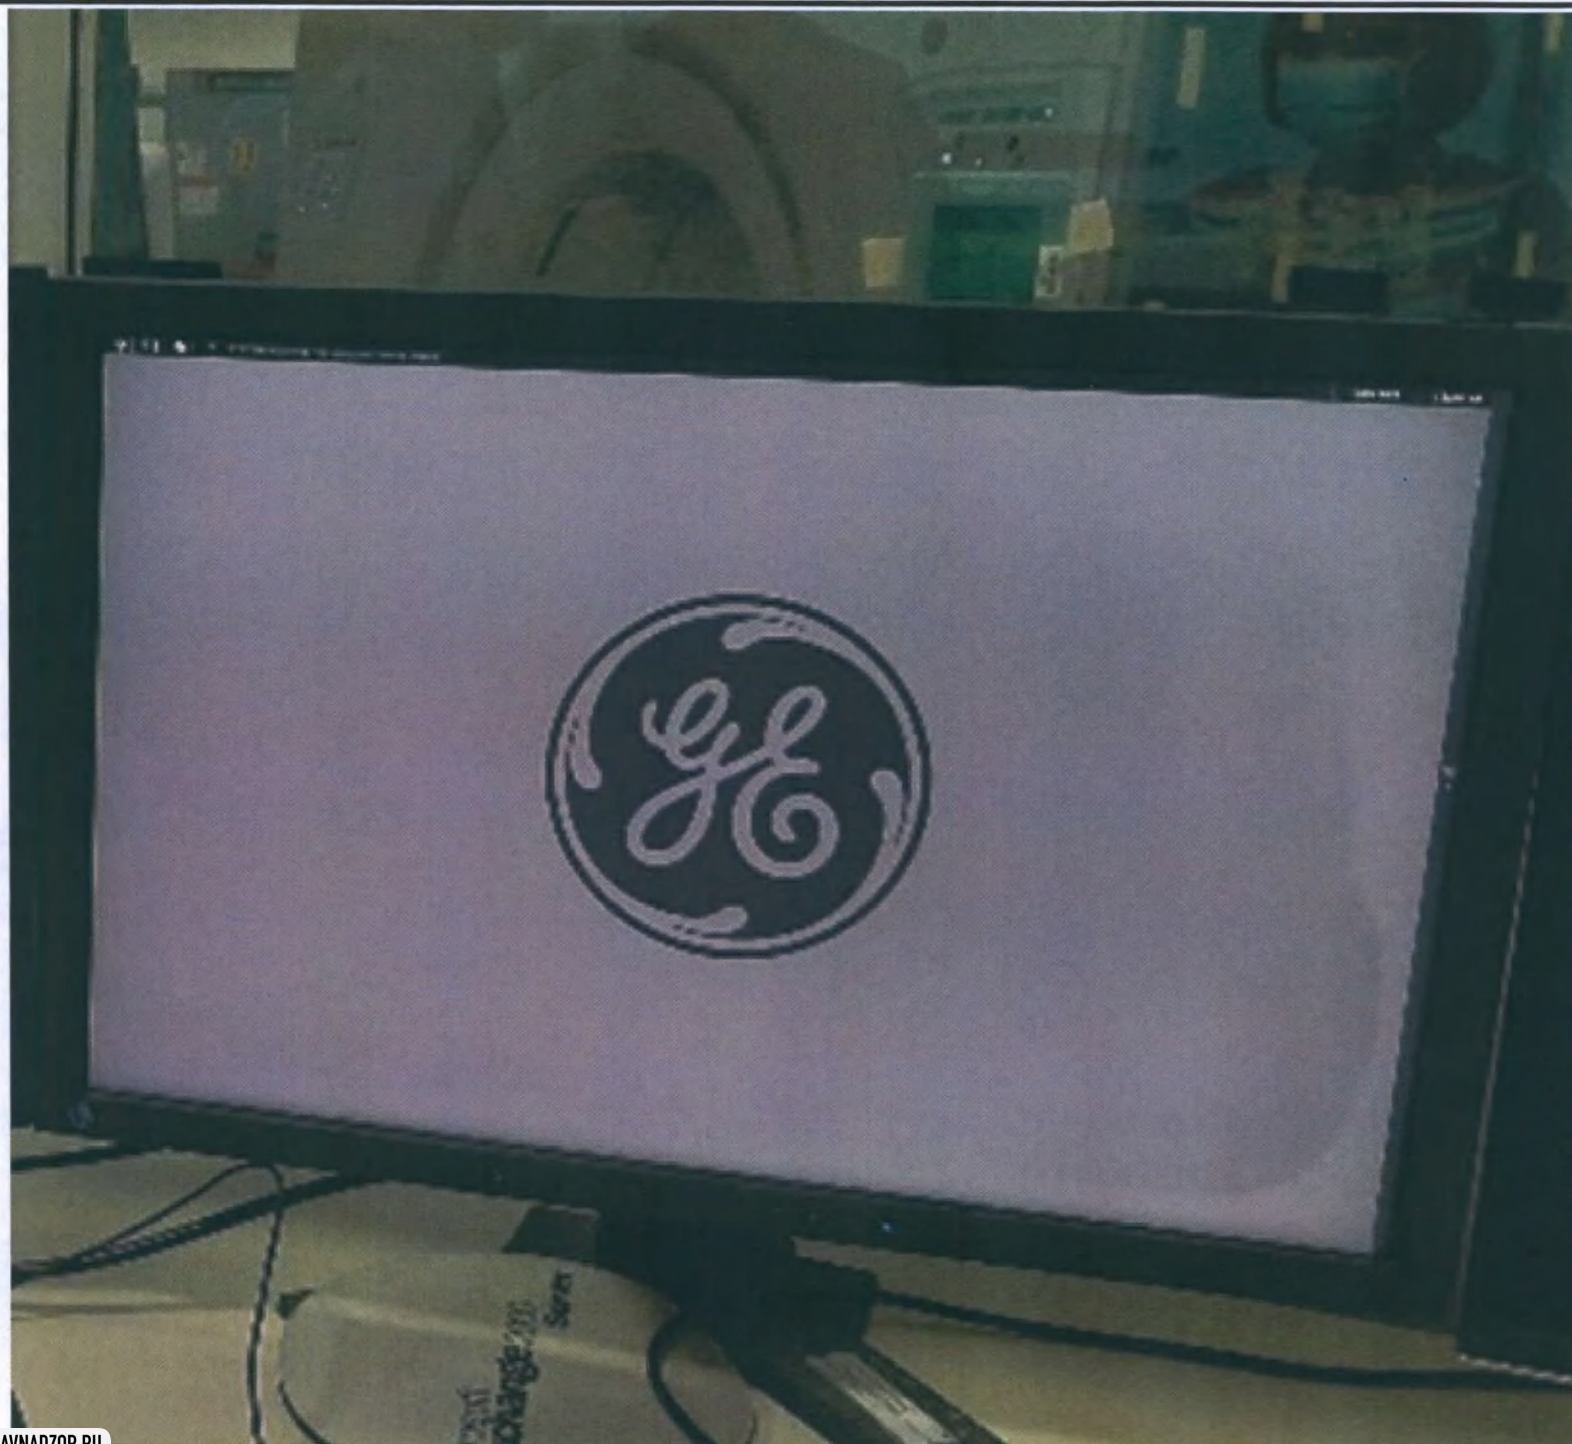

75. Автоматическое устройство для введения контрастного вещества. (не более 10 шт.).




75. Автоматическое устройство для введения контрастного вещества. (не более 10 шт.).



75. Автоматическое устройство для введения контрастного вещества. (не более 10 шт.).



75. Автоматическое устройство для введения контрастного вещества. (не более 10 шт.).

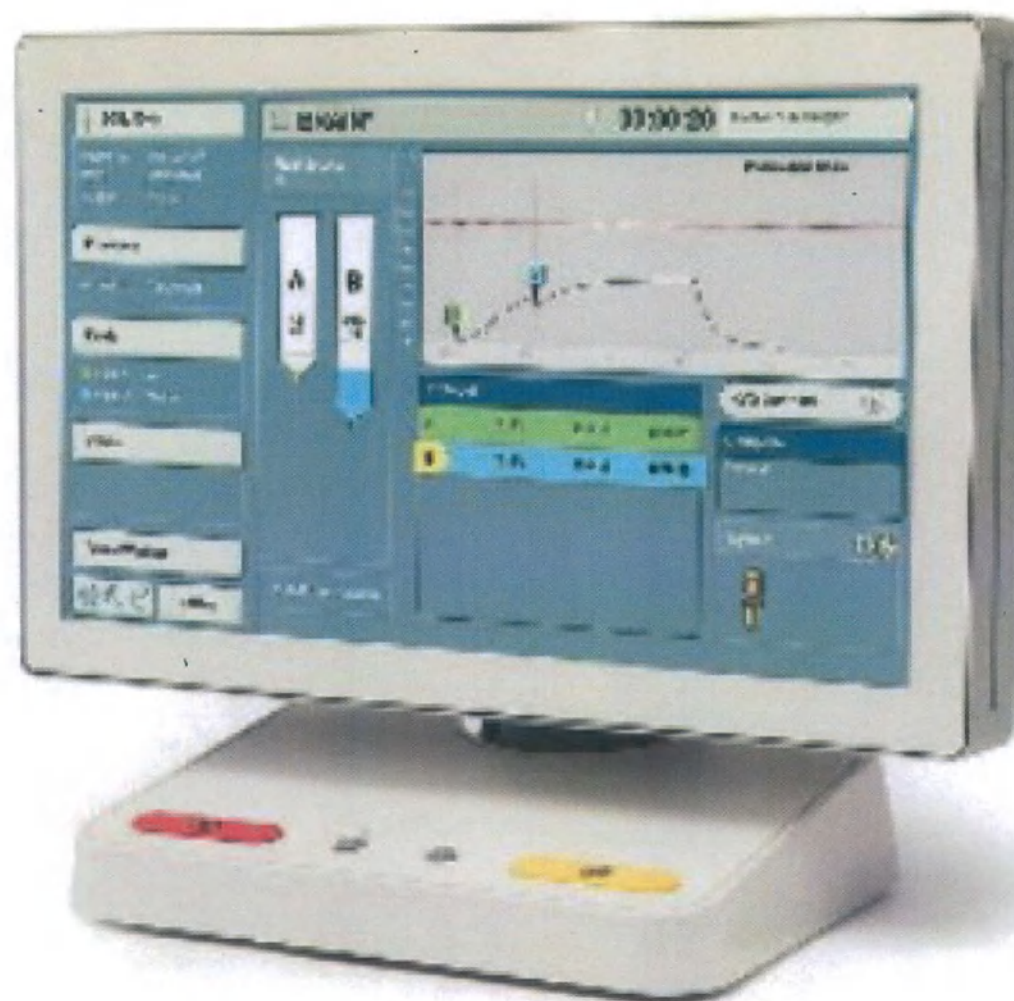

75. Автоматическое устройство для введения контрастного вещества. (не более 10 шт.).



75. Автоматическое устройство для введения контрастного вещества. (не более 10 шт.).



75. Автоматическое устройство для введения контрастного вещества. (не более 10 шт.).



75. Автоматическое устройство для введения контрастного вещества. (не более 10 шт.).







77. Магистралы для инжекторов (не более 500 шт.).



Contrast	
IV Contrast	<u>On</u>
IV Contrast Settings	<u>IV: Iodine, 370, 300 ml</u>
Enhanced Xstream Injector	<u>On</u>
Injector Settings	<u>3, 150 PSI, 195 ml</u>
Oral Contrast	<u>On</u>
Oral Contrast Settings	<u>Oral: Oral, 0, 750 ml</u>







82. Распределительный щит питания.



82. Распределительный щит питания.



82. Распределительный щит питания.



83. Кабели силовые (не более 20 шт.).




84. Кабели управляющие (не более 20 шт.).





86. Кабели коаксиальные (не более 10 шт.).

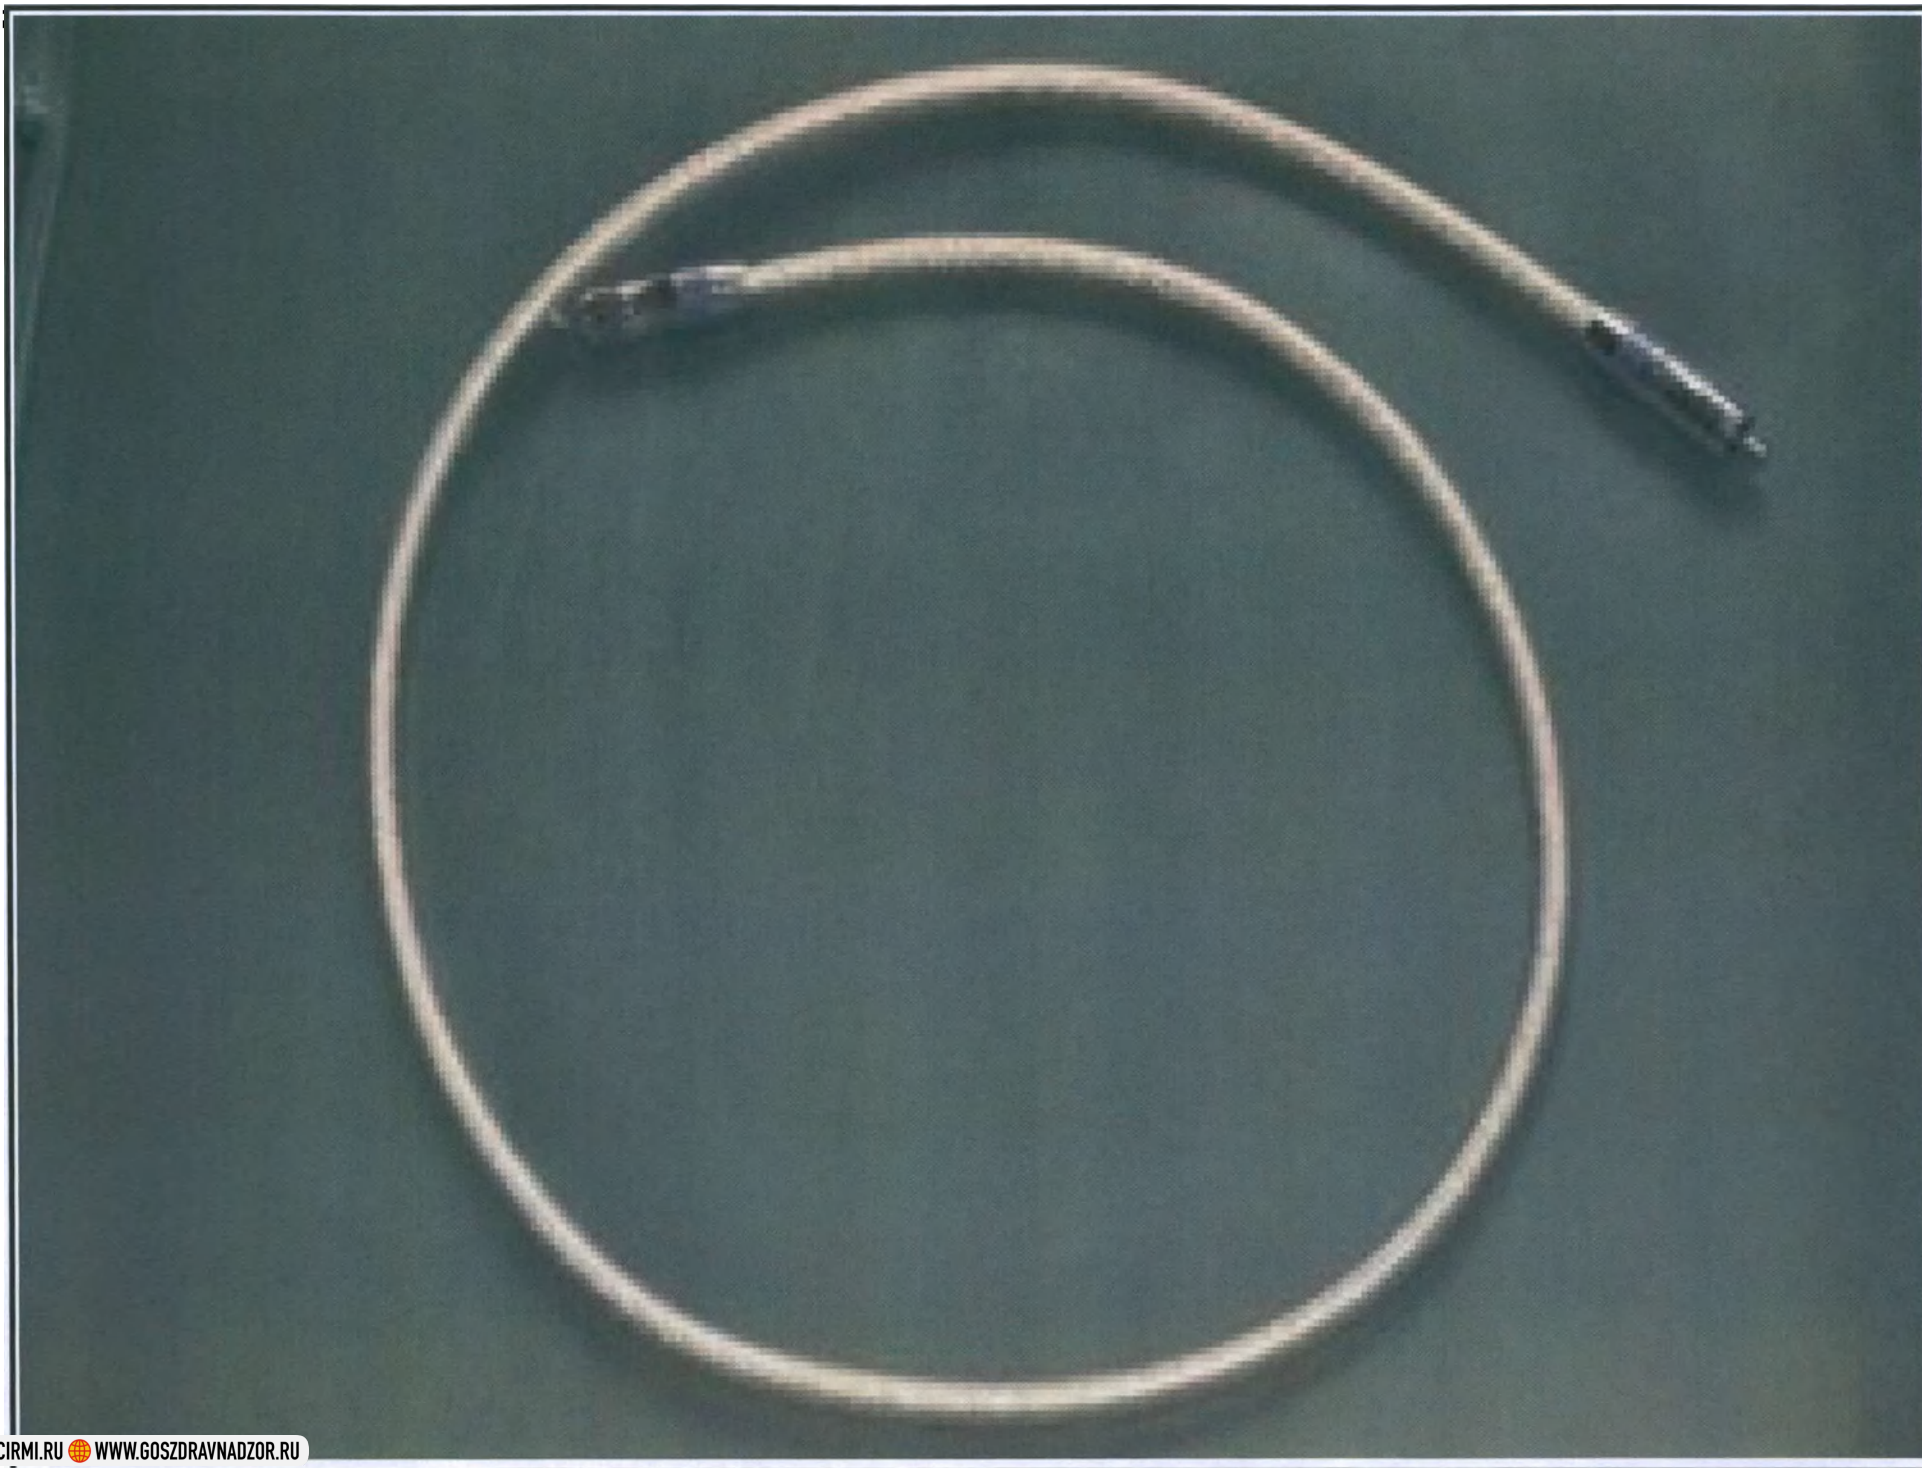

87. Кабели питания (не более 10 шт.).



88. Кабели оптические для передачи информации (не более 10 шт.).



89. Кабели соединительные (не более 10 шт.).



90. Кабели для подключения (не более 100 шт.).




91 . Кабели сетевые (не более 10 шт.).




92. Сетевое оборудование: - переключатели (не более 20 шт.); - коммутаторы (не более 20 шт.).



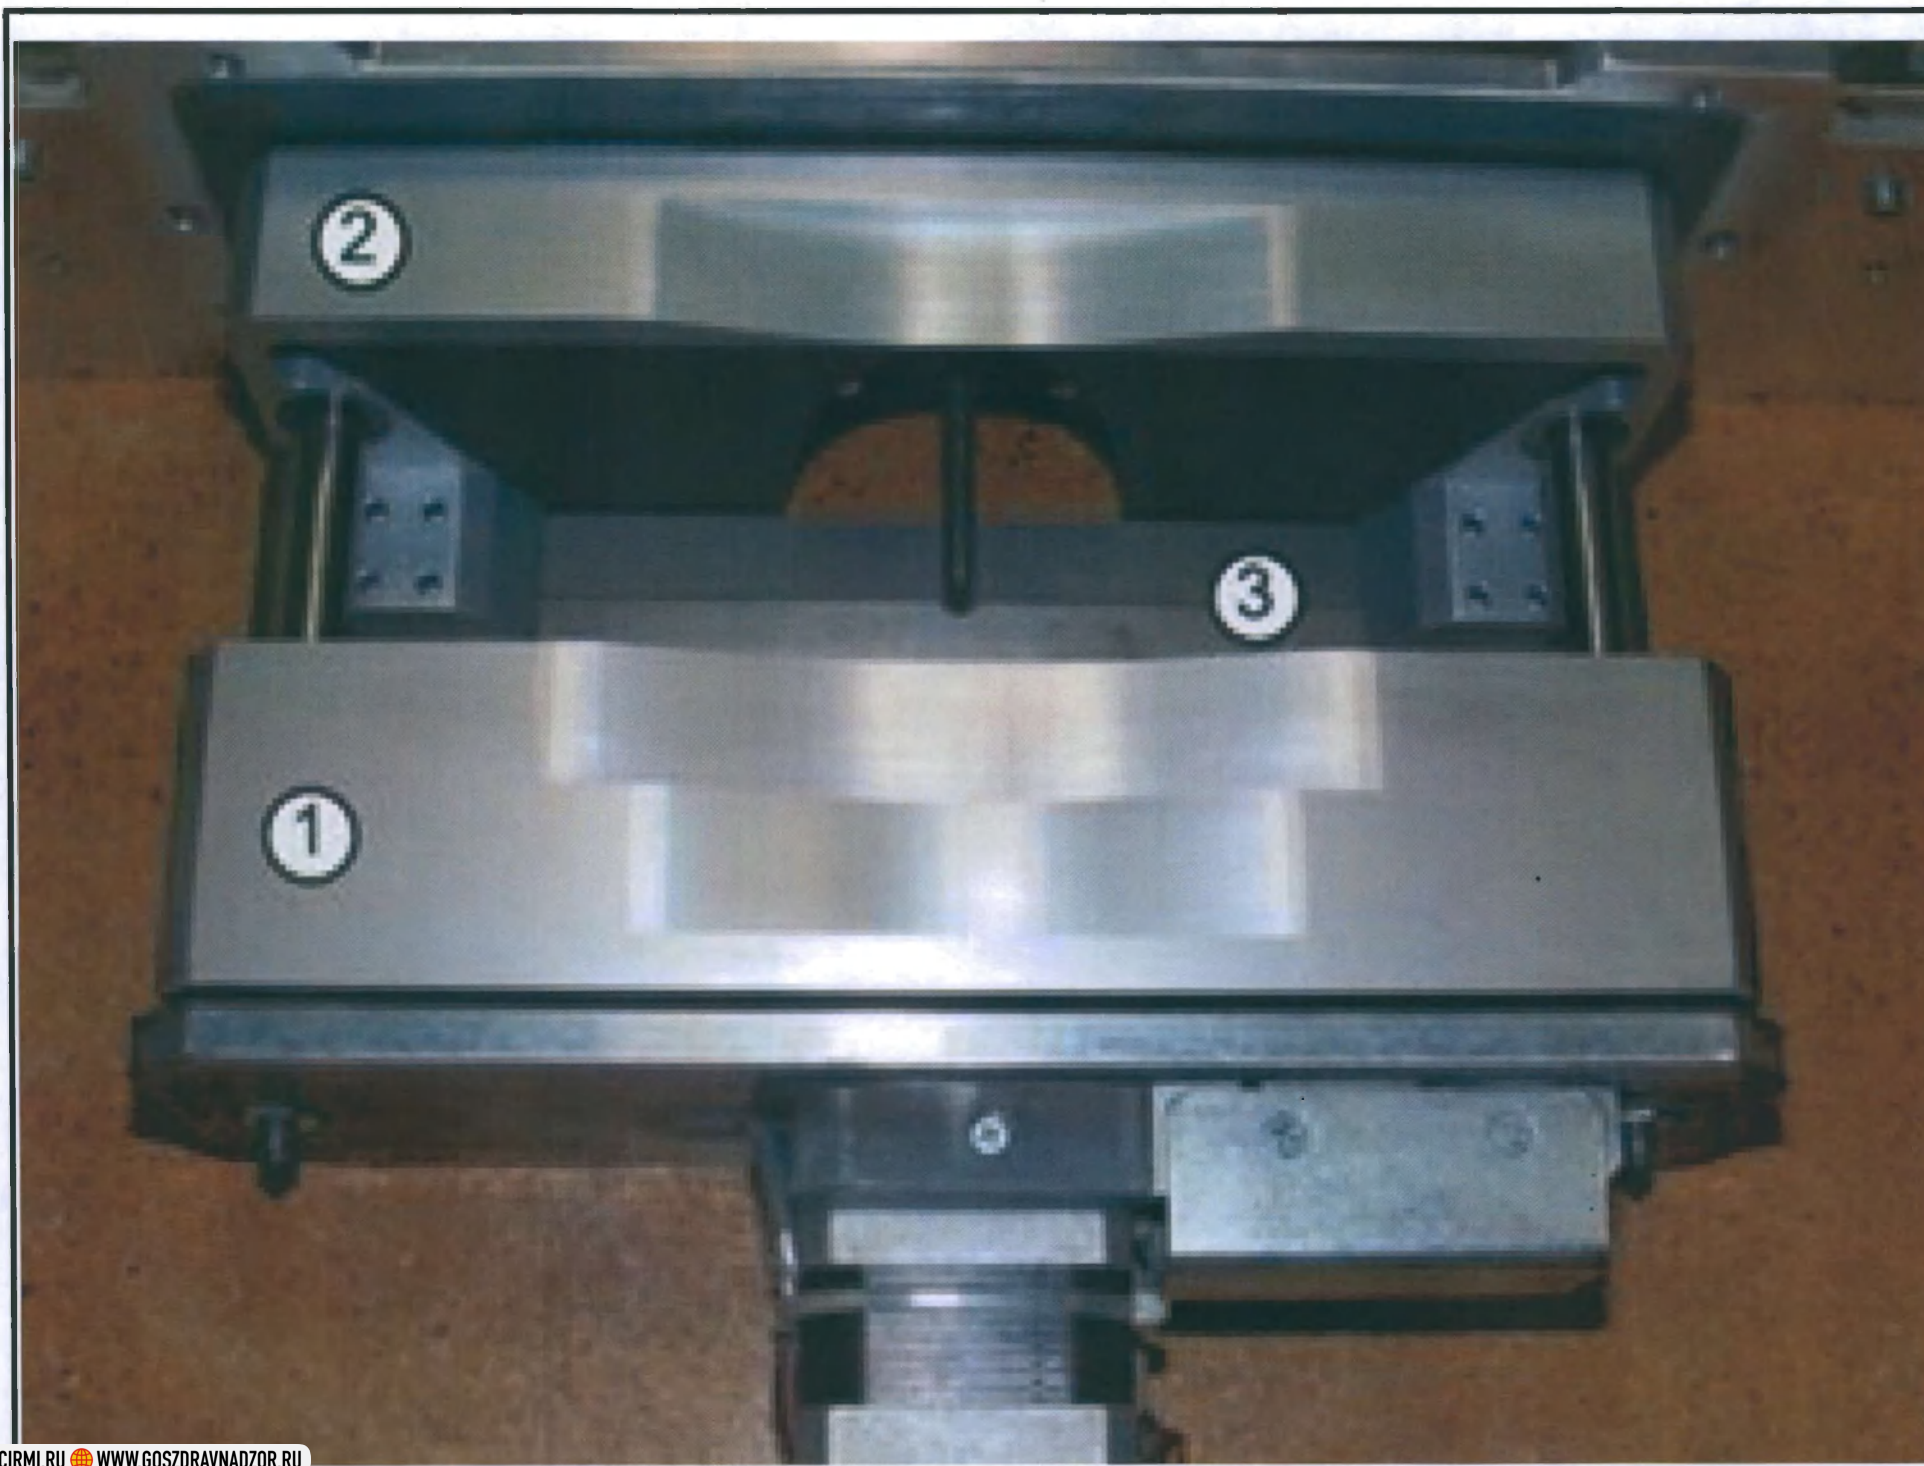



95. Помпы масляные (не более 5 шт.).

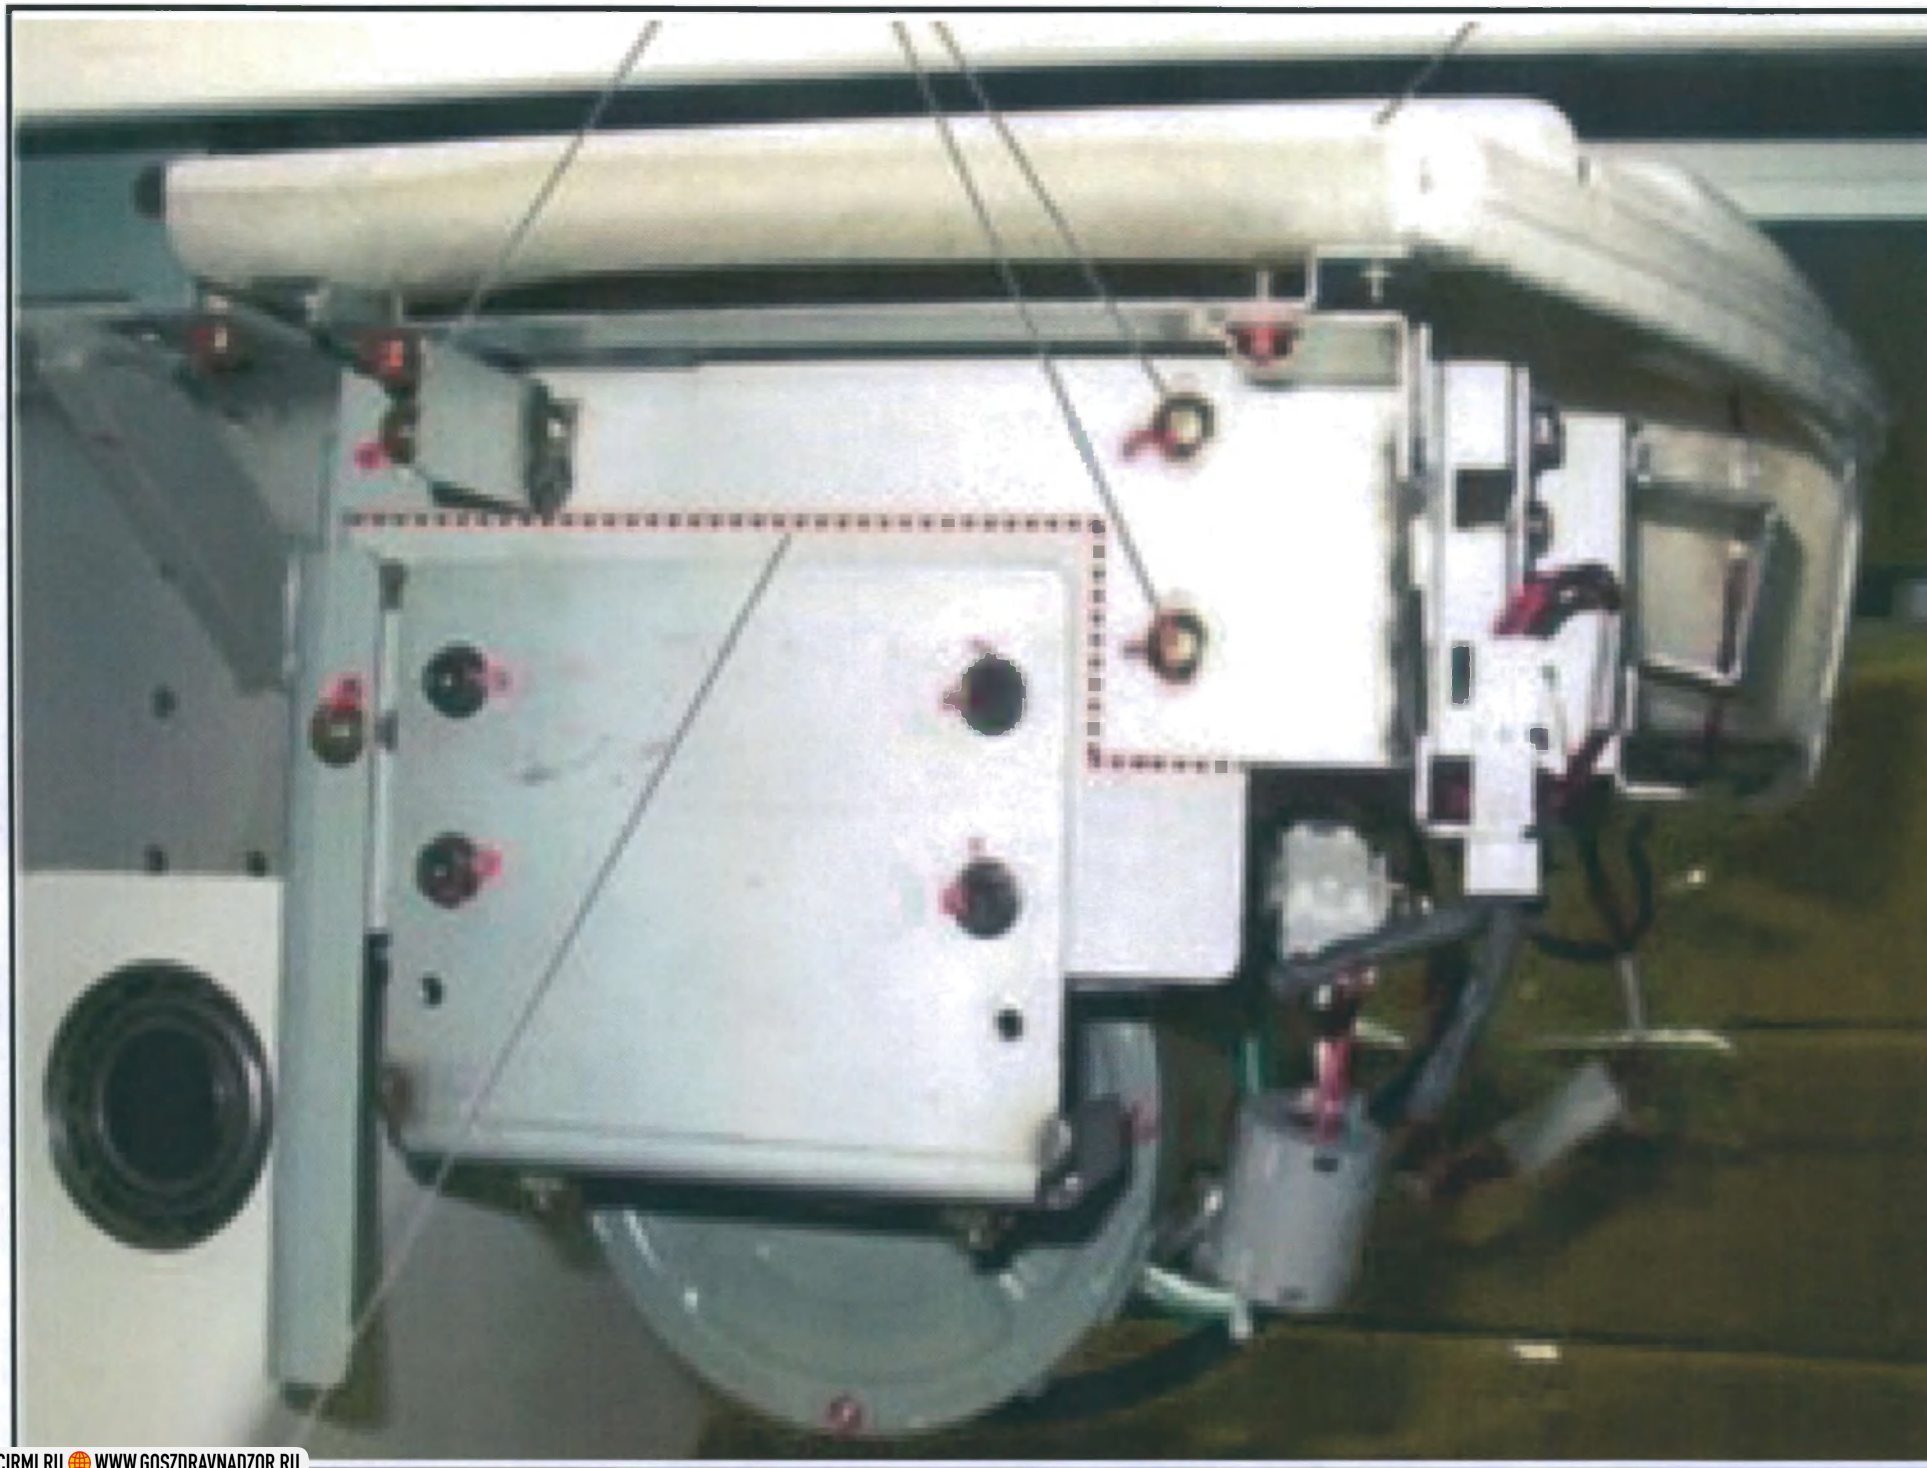









99. Набор сервисный: - предохранители рентгенокомпьютерные электрические (не более 15 шт.); - вставки главные (не более 15 шт.); - электрические конденсаторы (не более 15 шт.); - резисторы (не более 15 шт.); - диоды (не более 15 шт.); - транзисторы (не более 15 шт.); - тиристоры (не более 15 шт.); - микросхемы (не более 15 шт.).




100.—Рентгенокомпьютерные соединители электрические (не более 5 шт.).

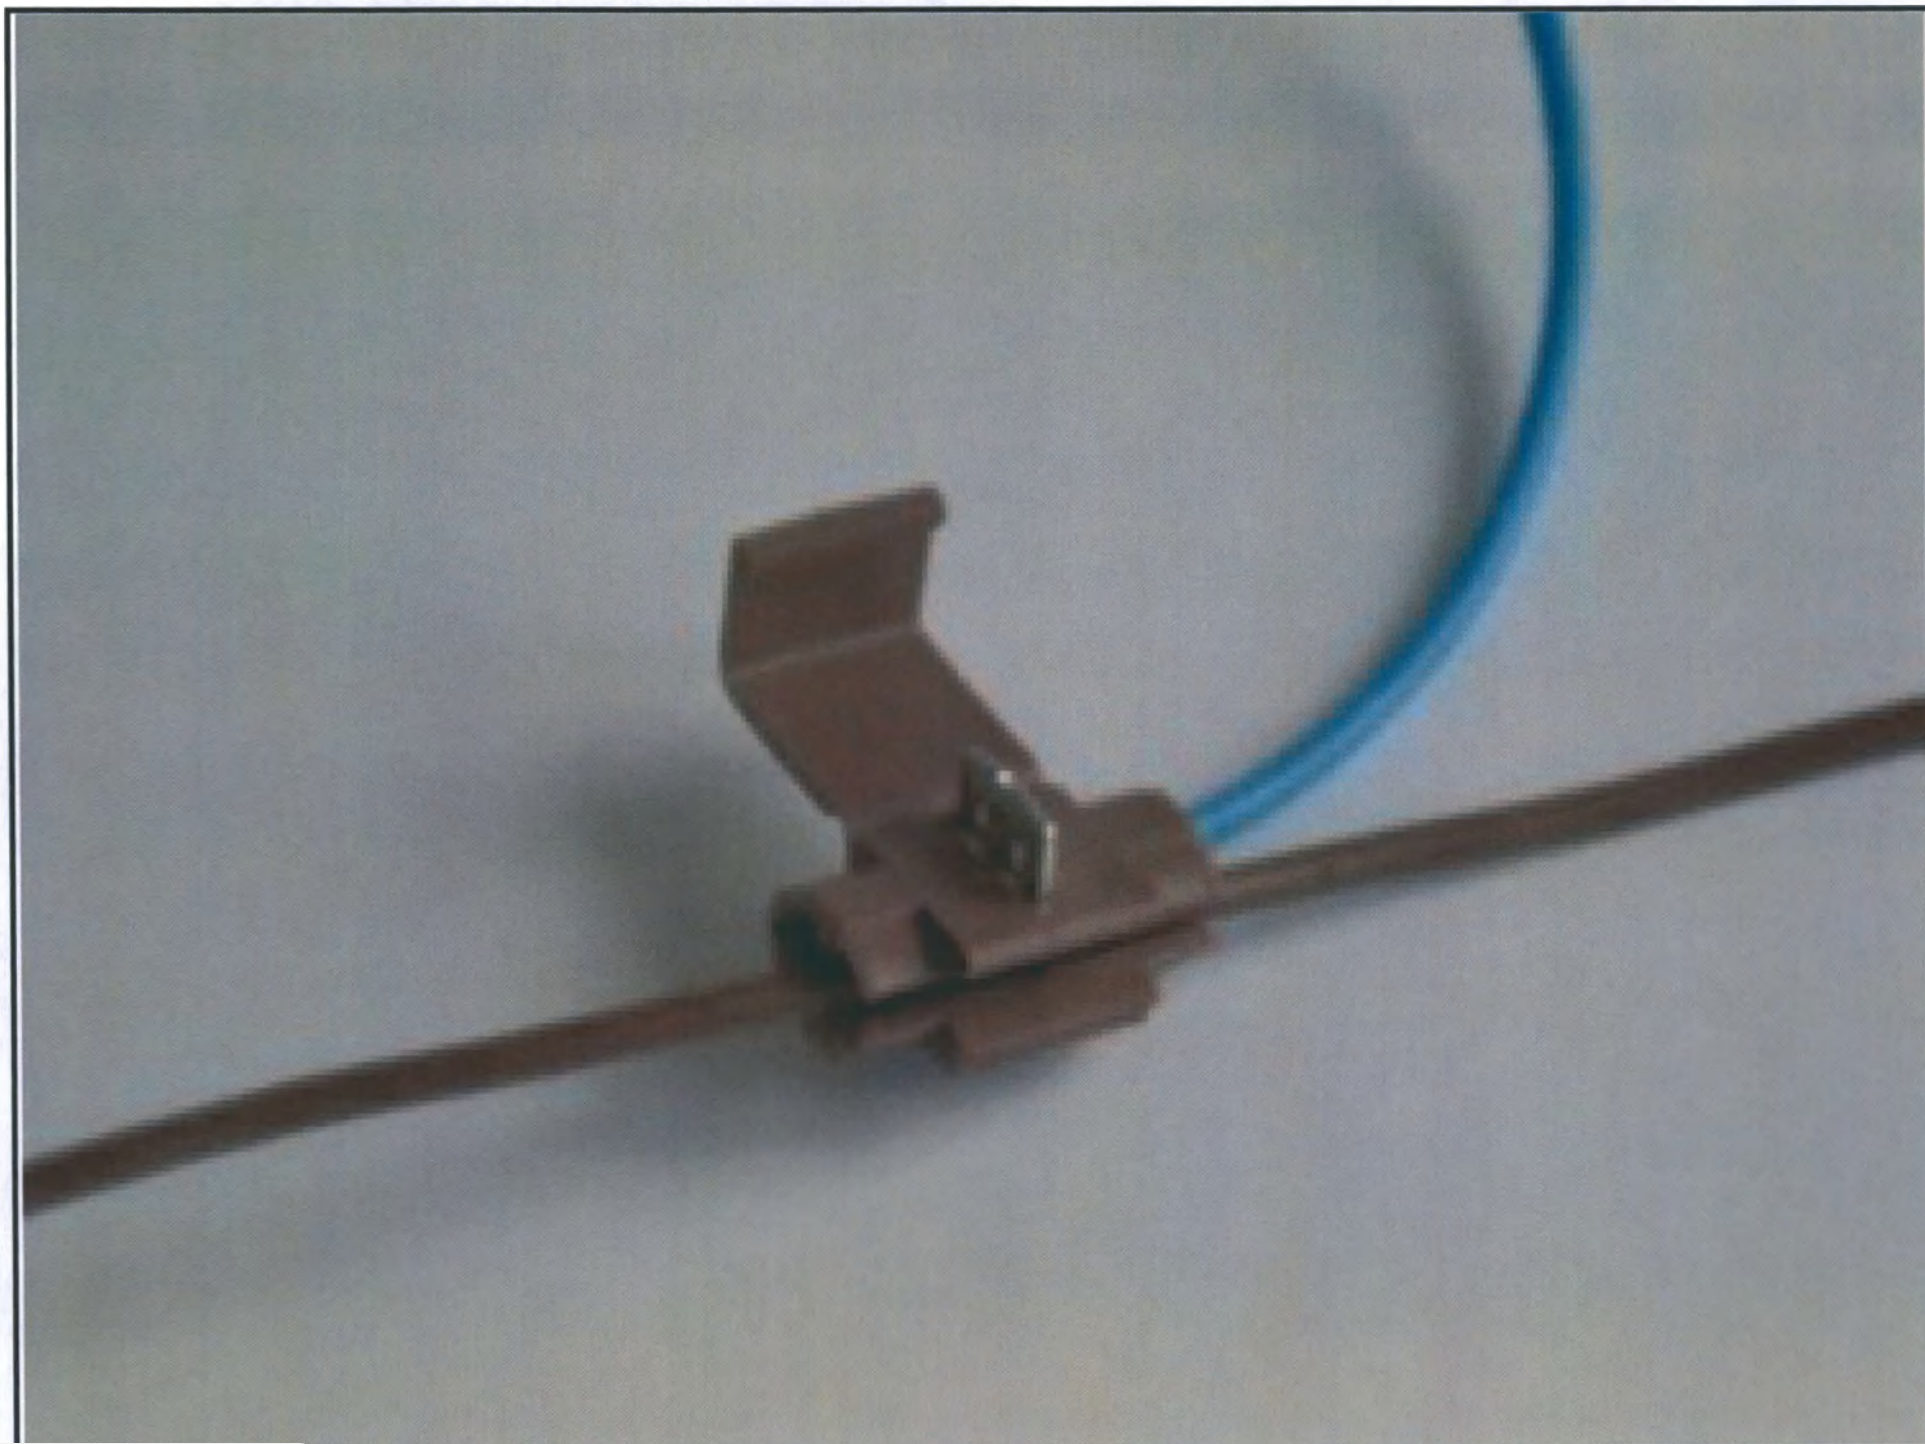


101. Рентгенокомпьютерные соединители механические (не более 5 шт.).

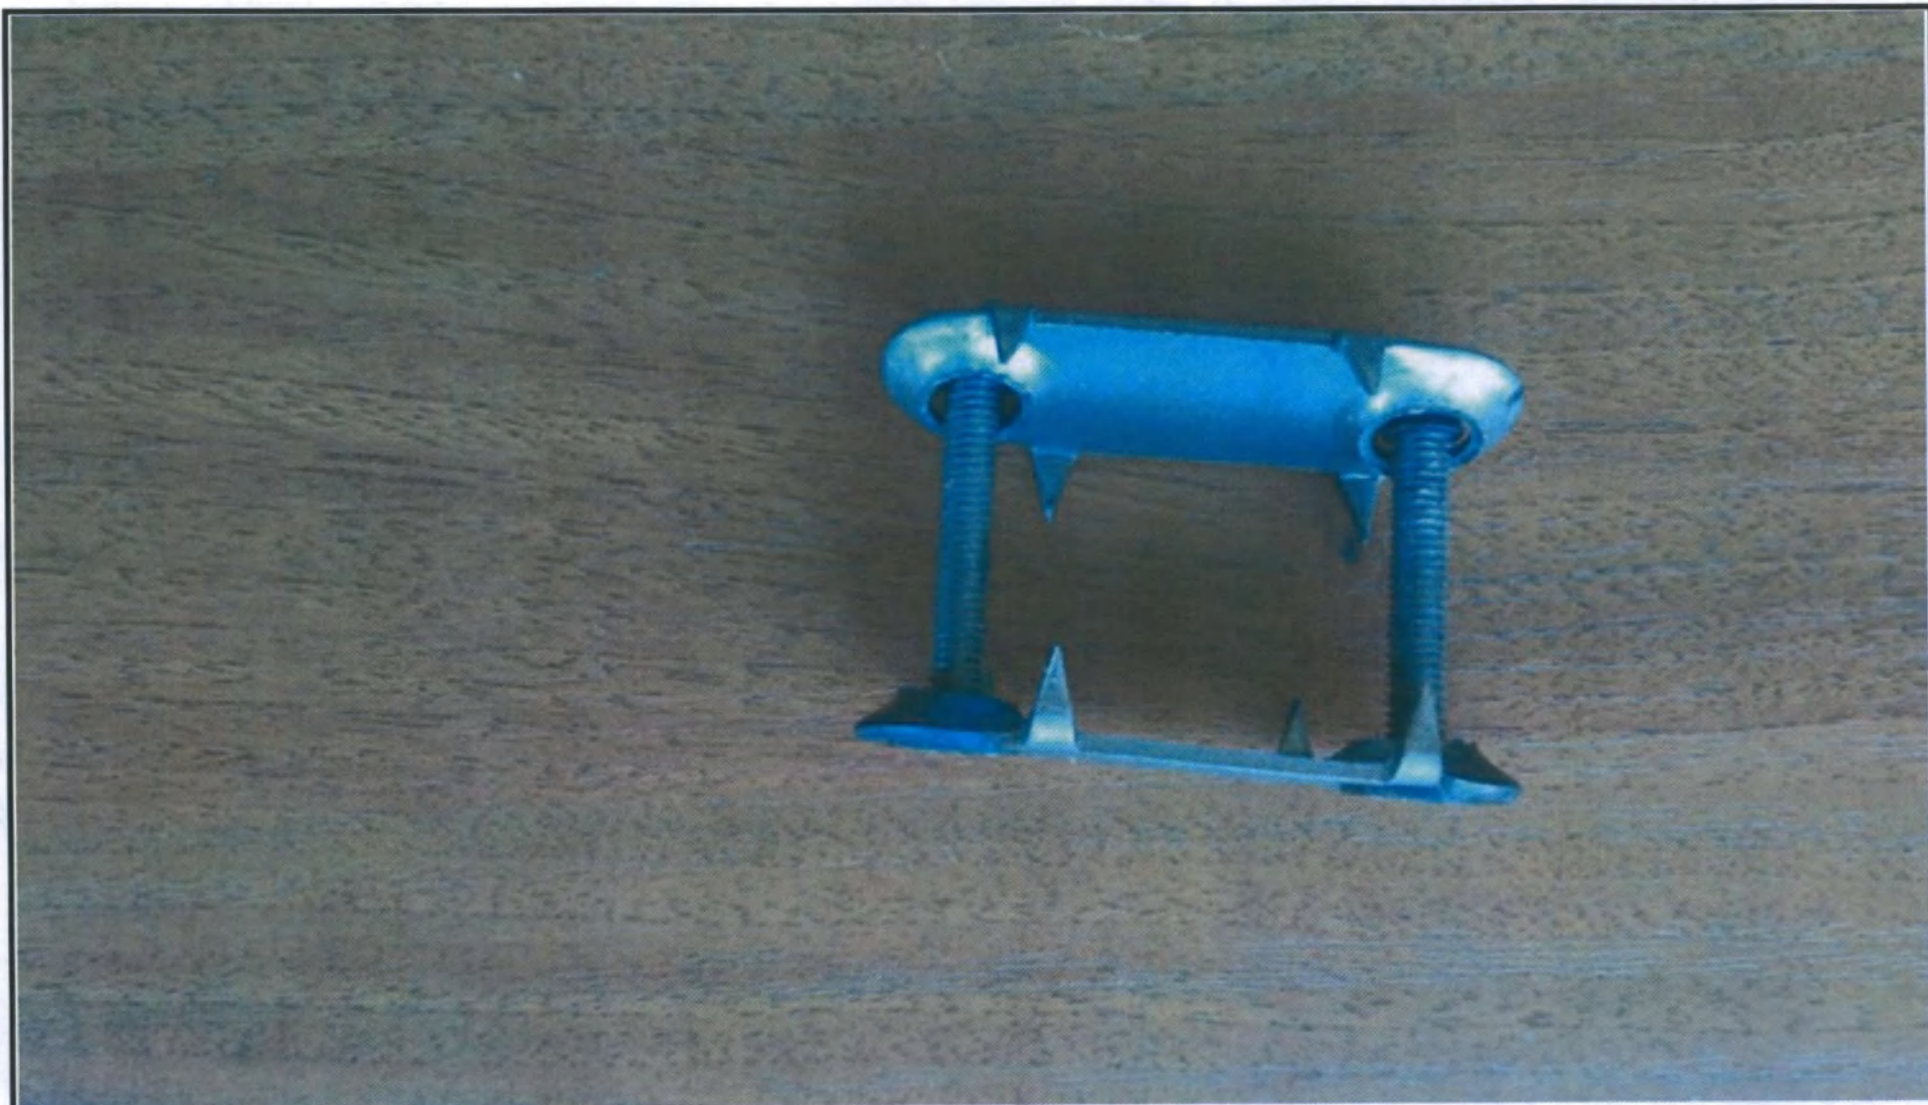

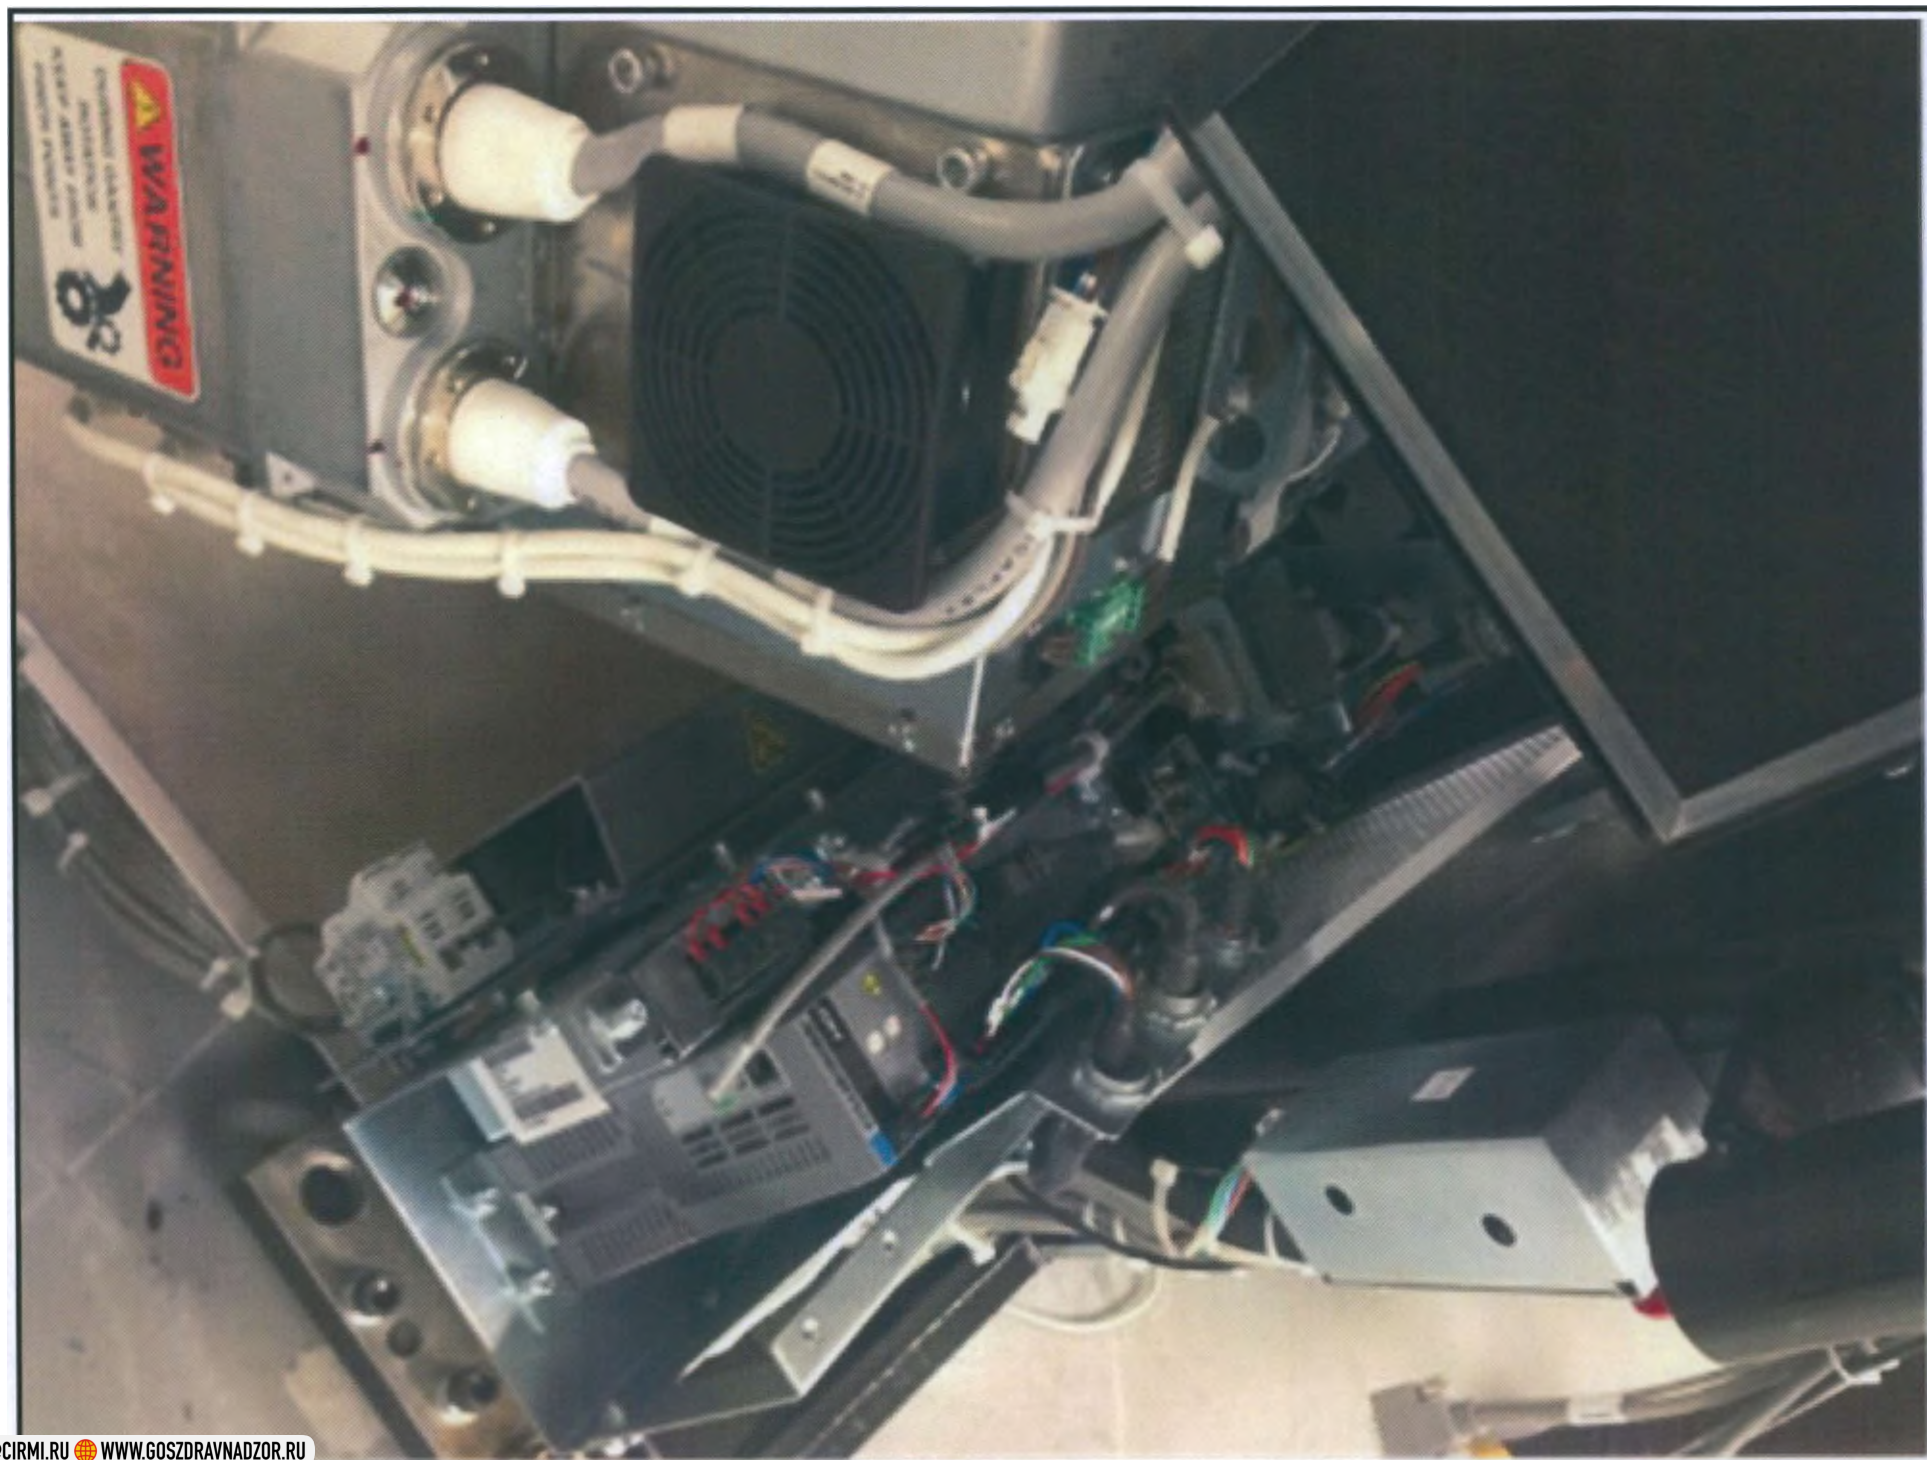



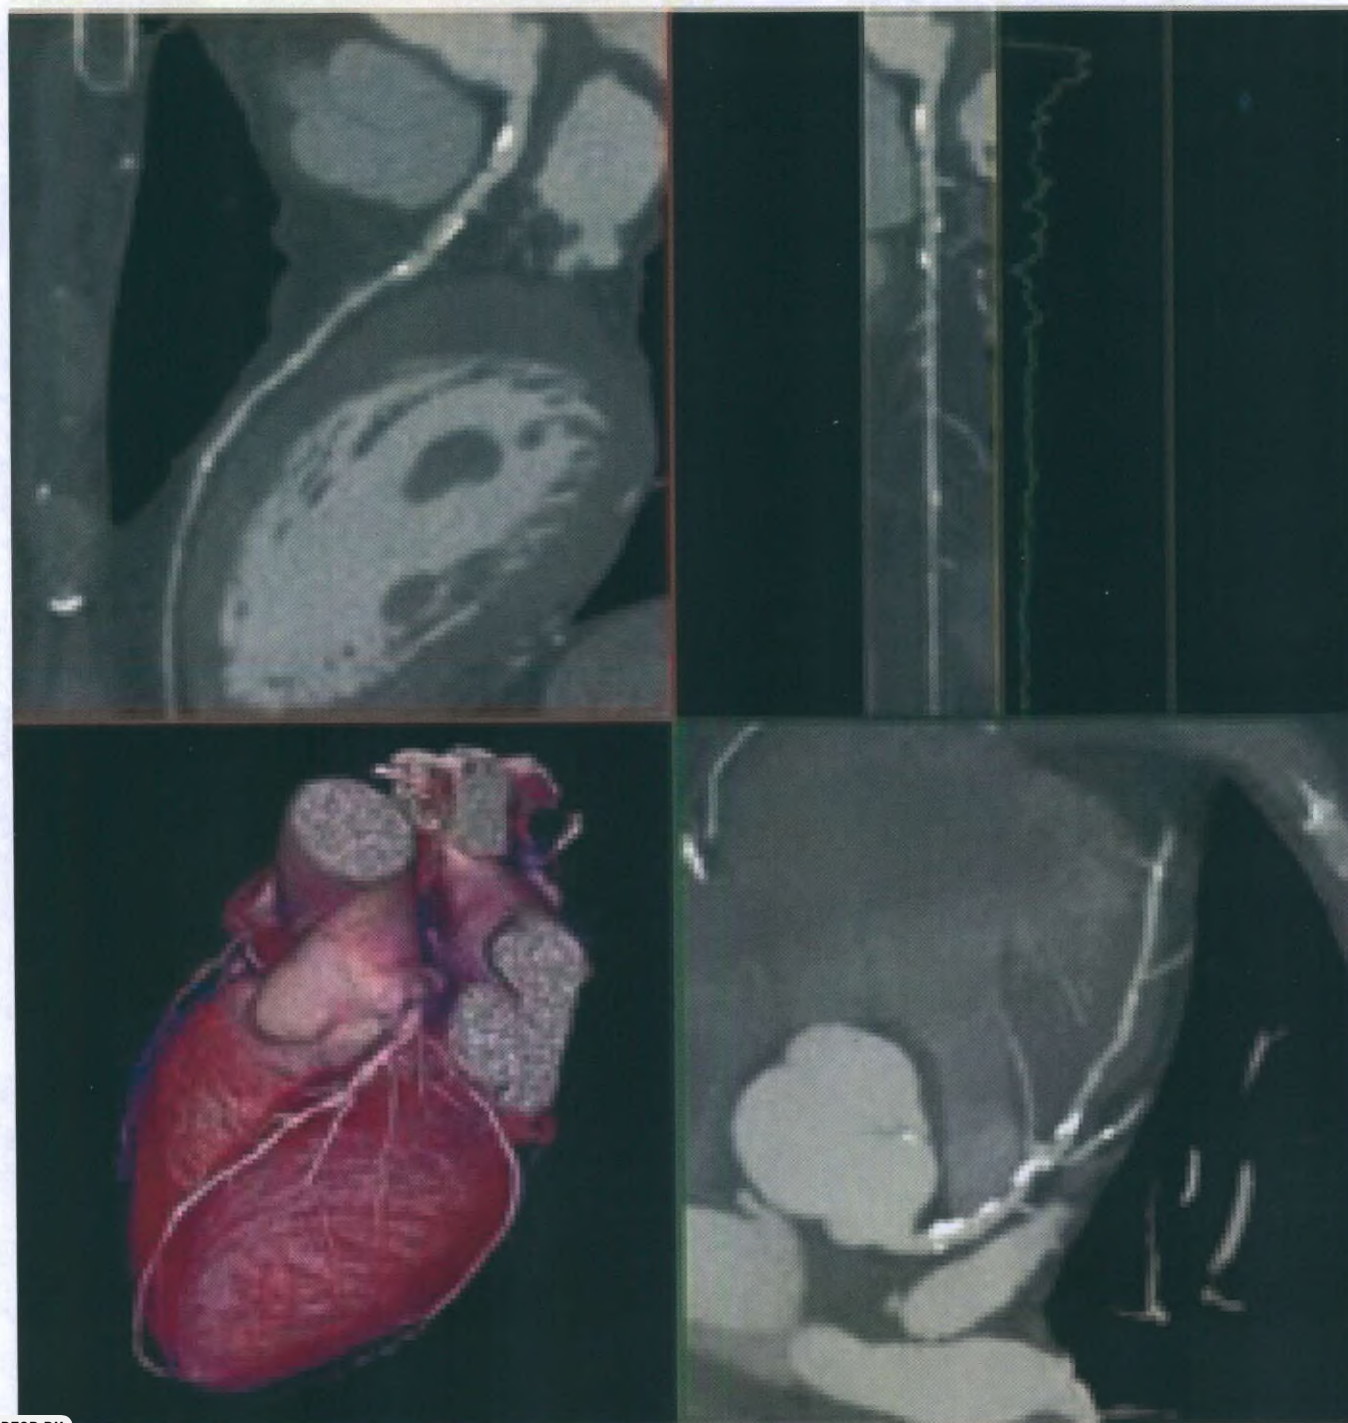

105. Панели управления гантри (не более 5 шт.).







108. Защитные короба для блока бесперебойного питания (не более 5 шт.).



109. Защитный чехол для педалей стола (не более 5 шт.).















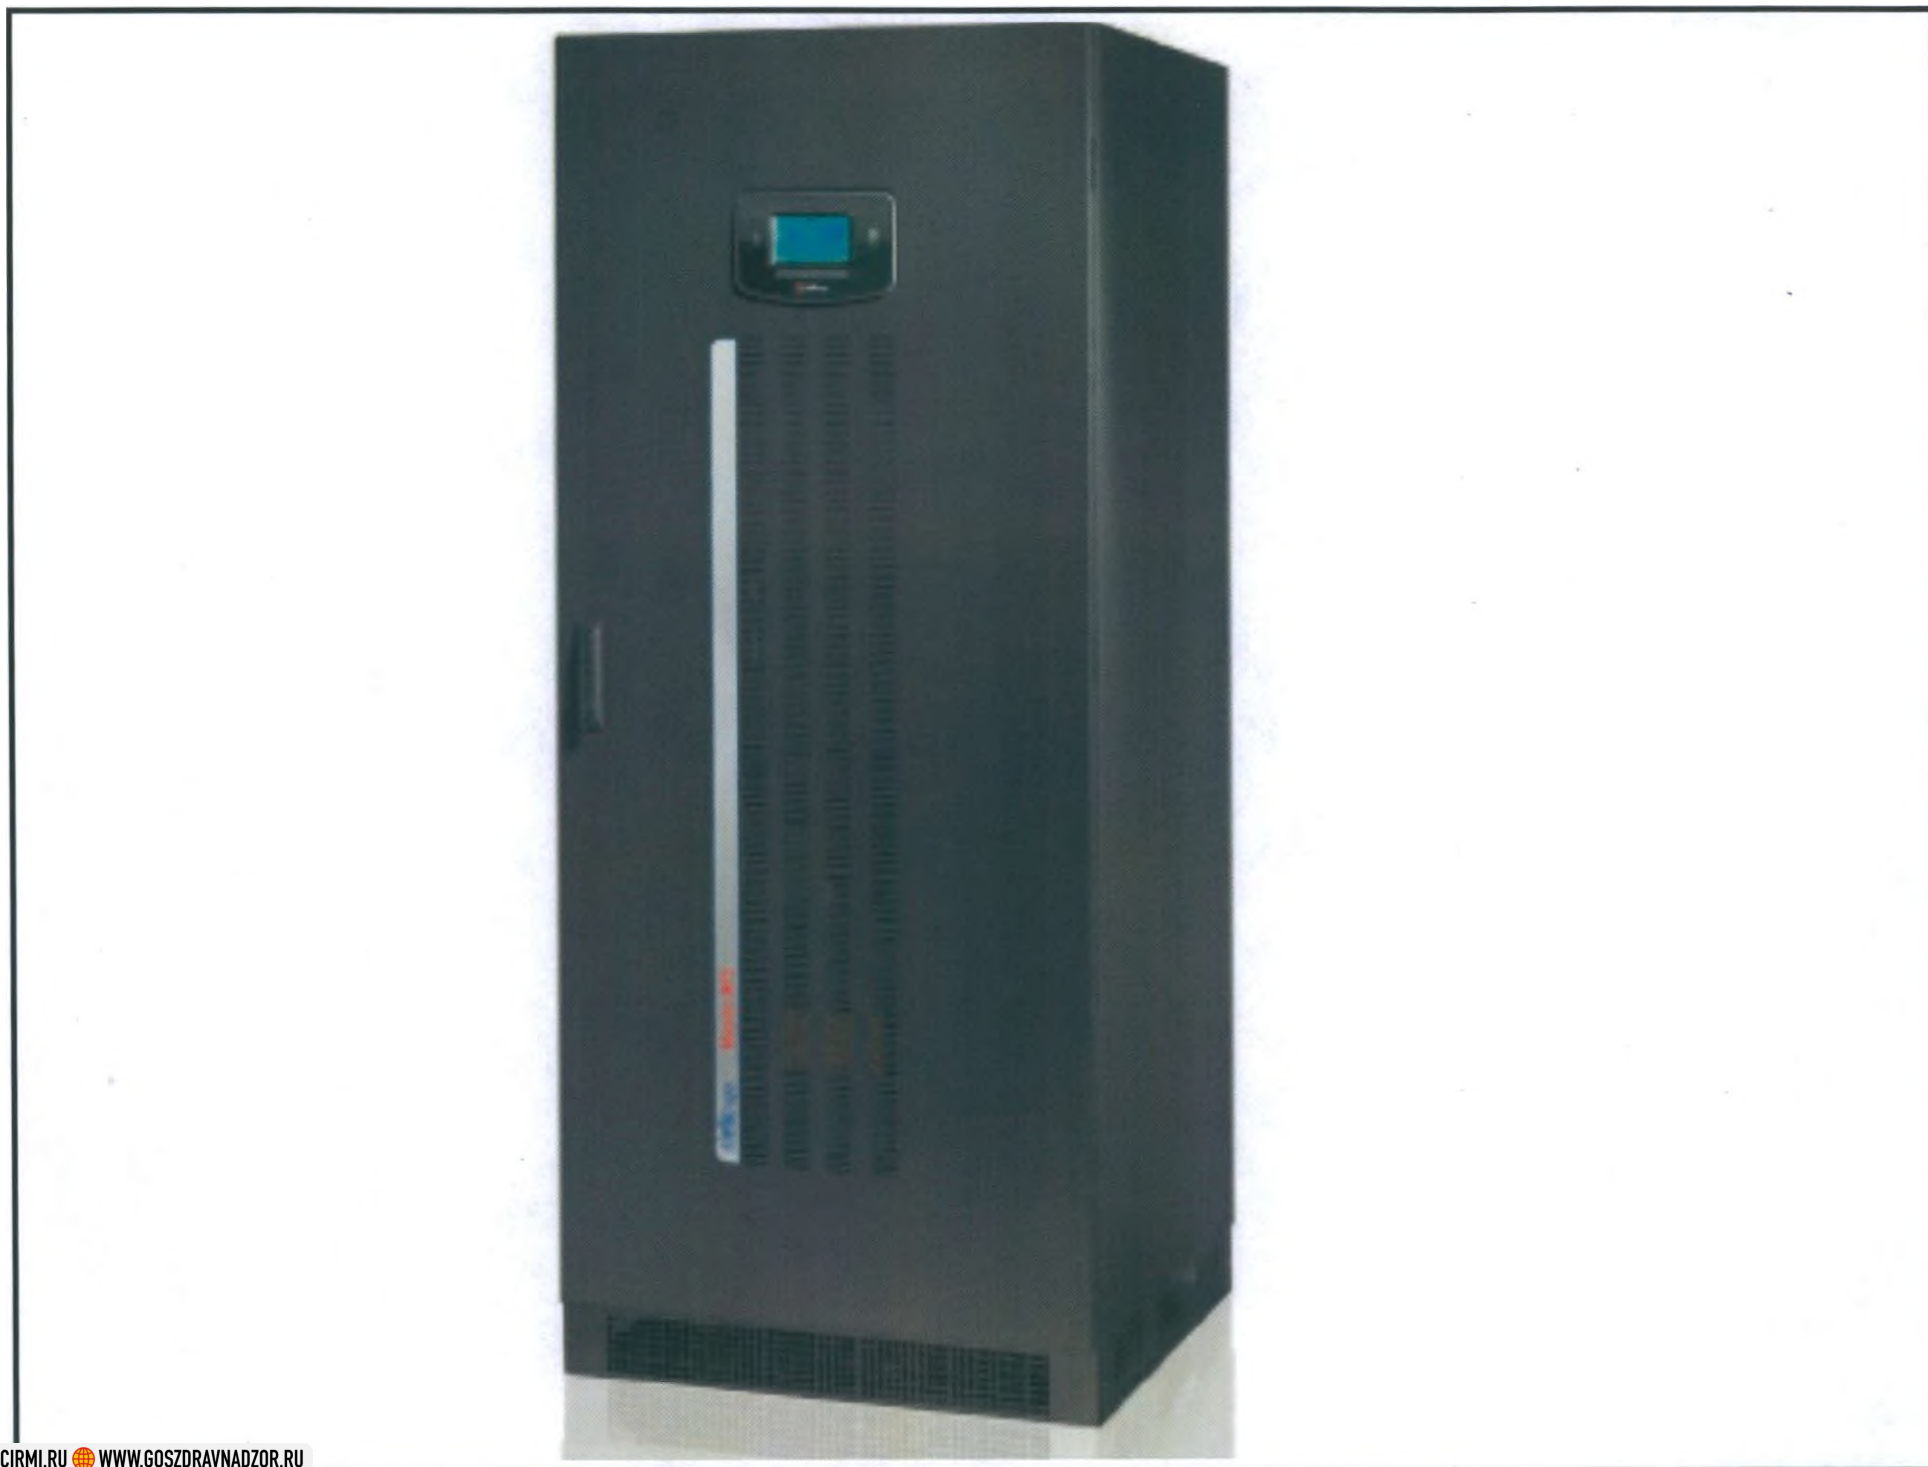



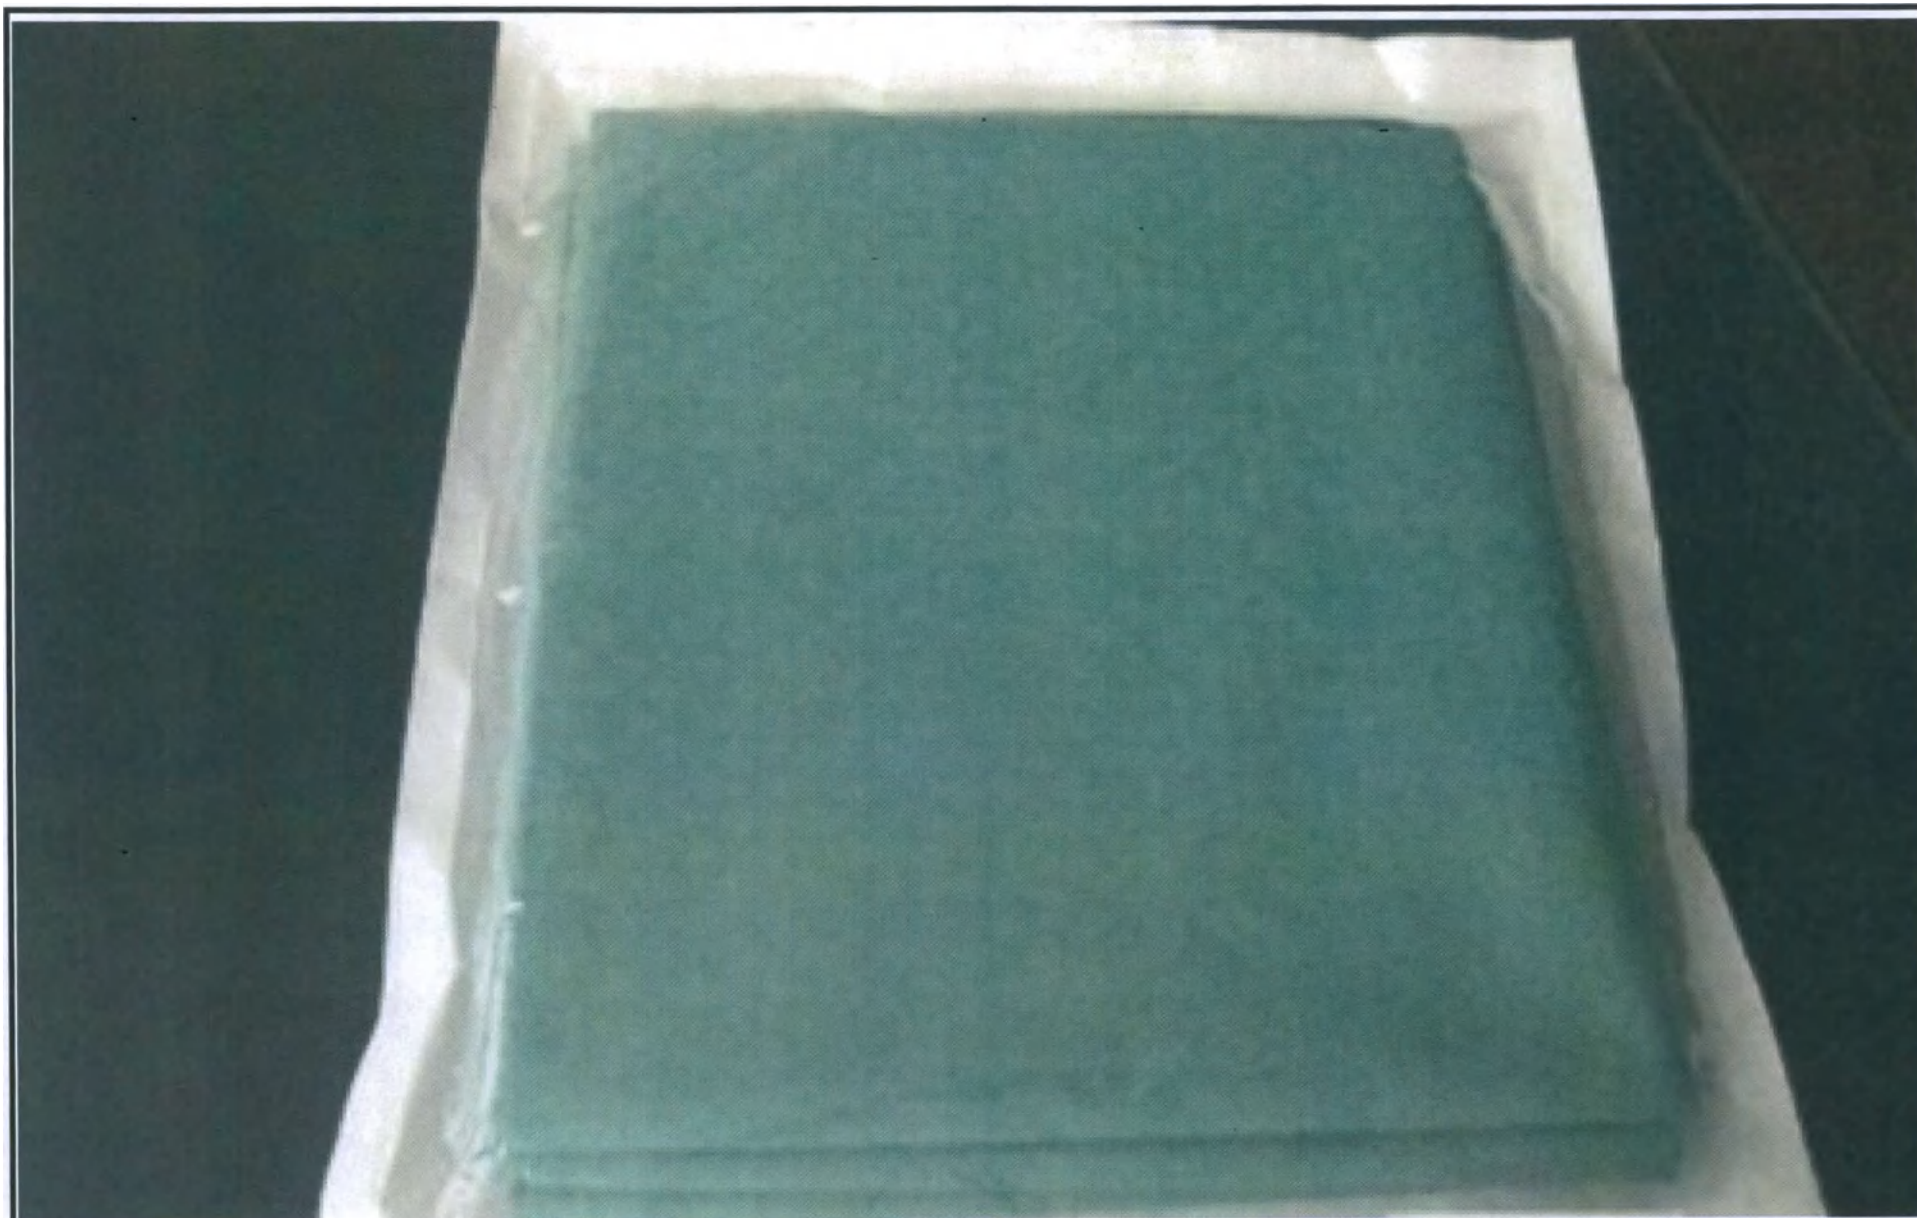














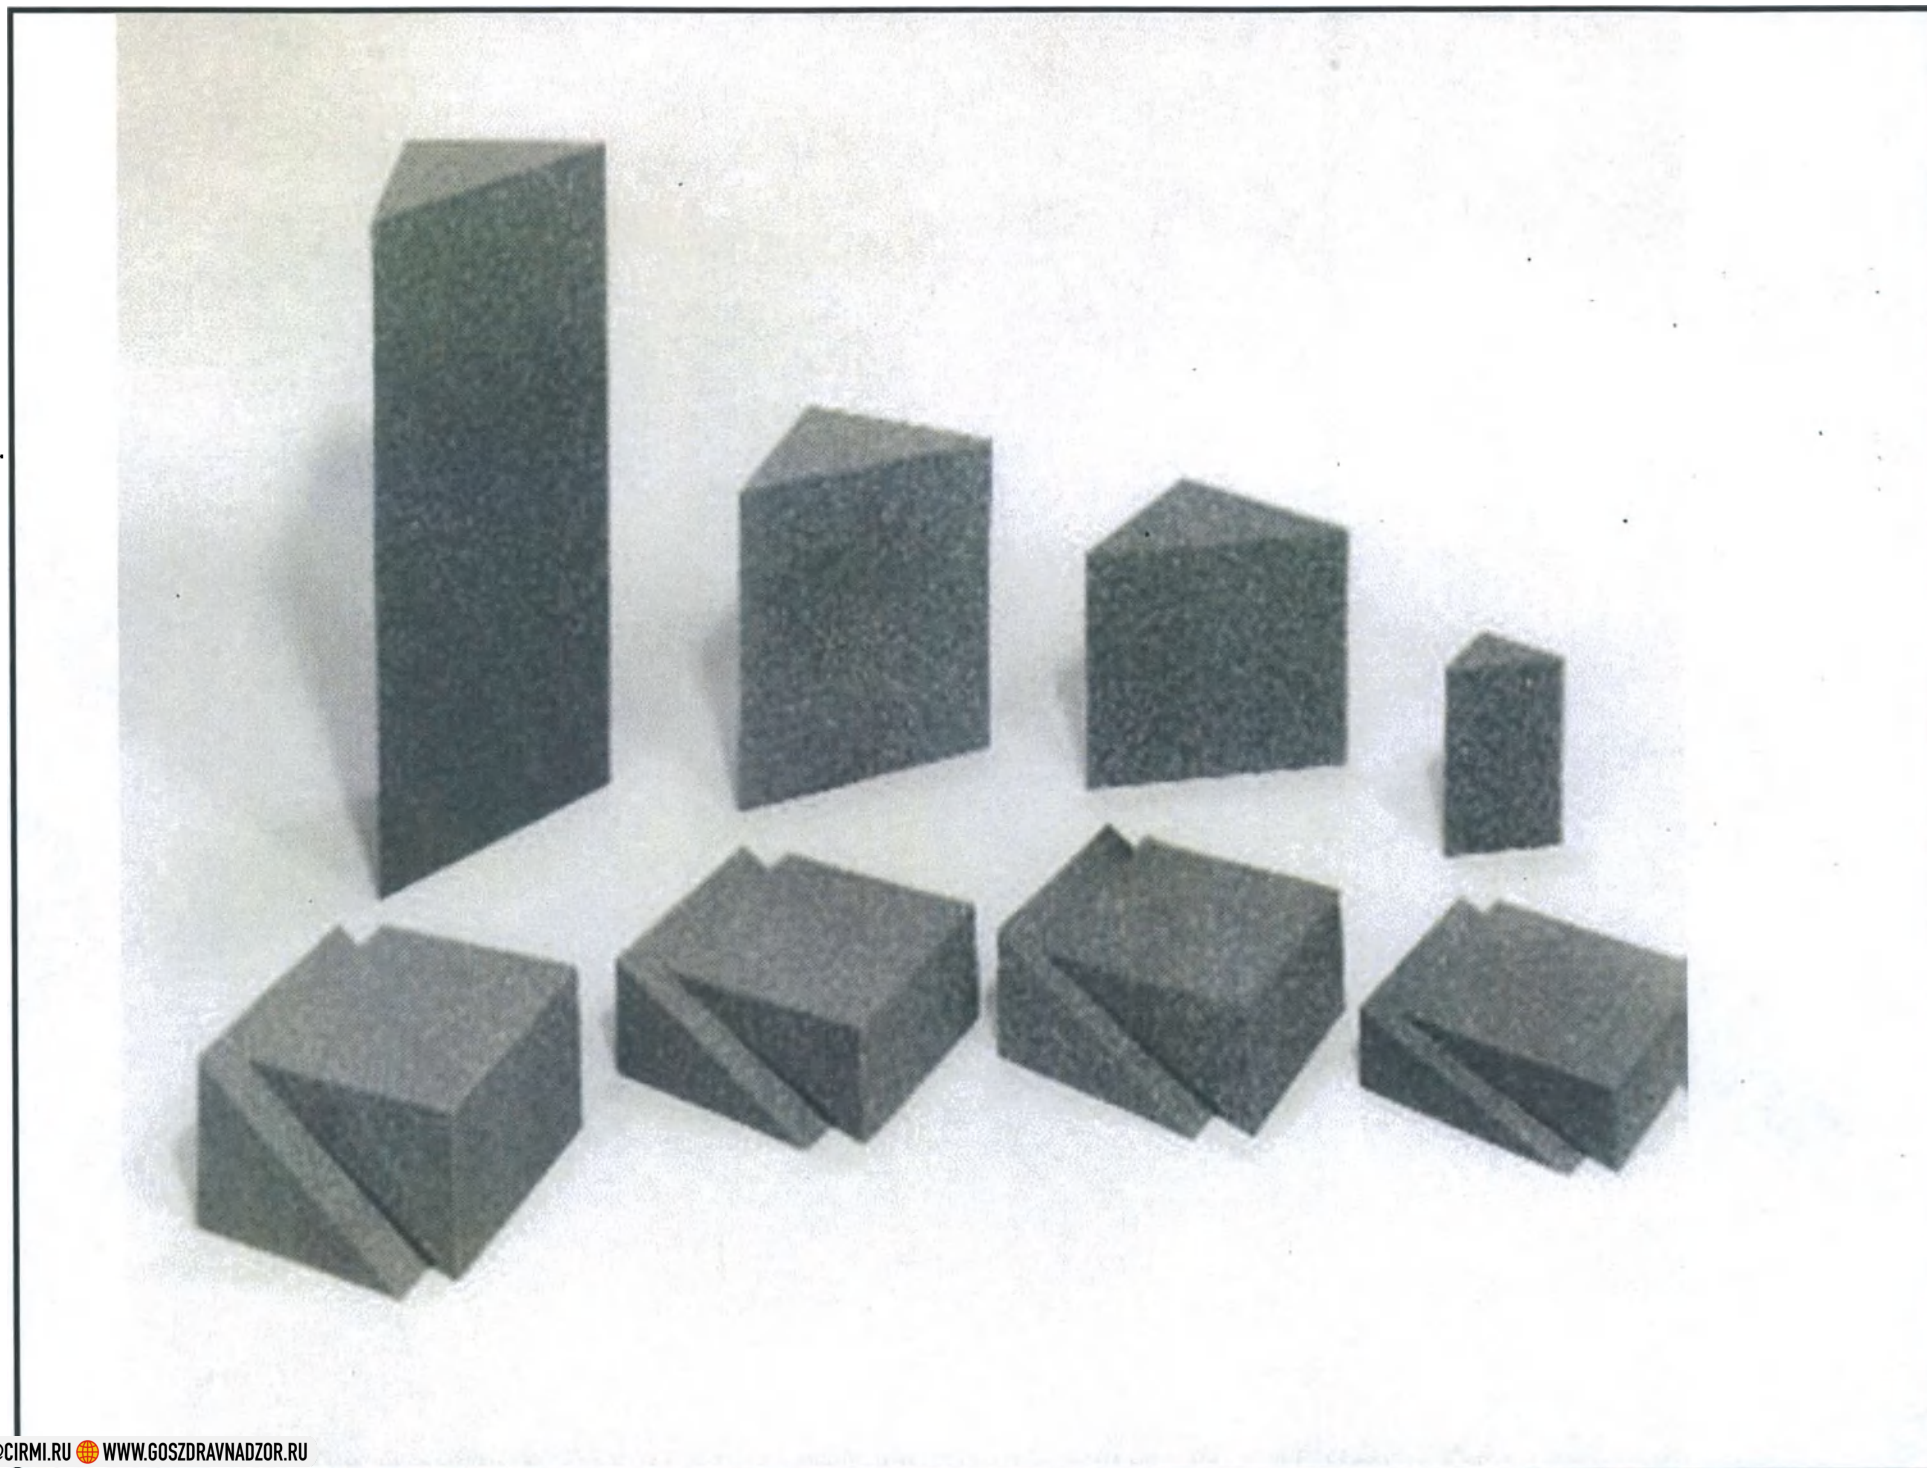


117. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).

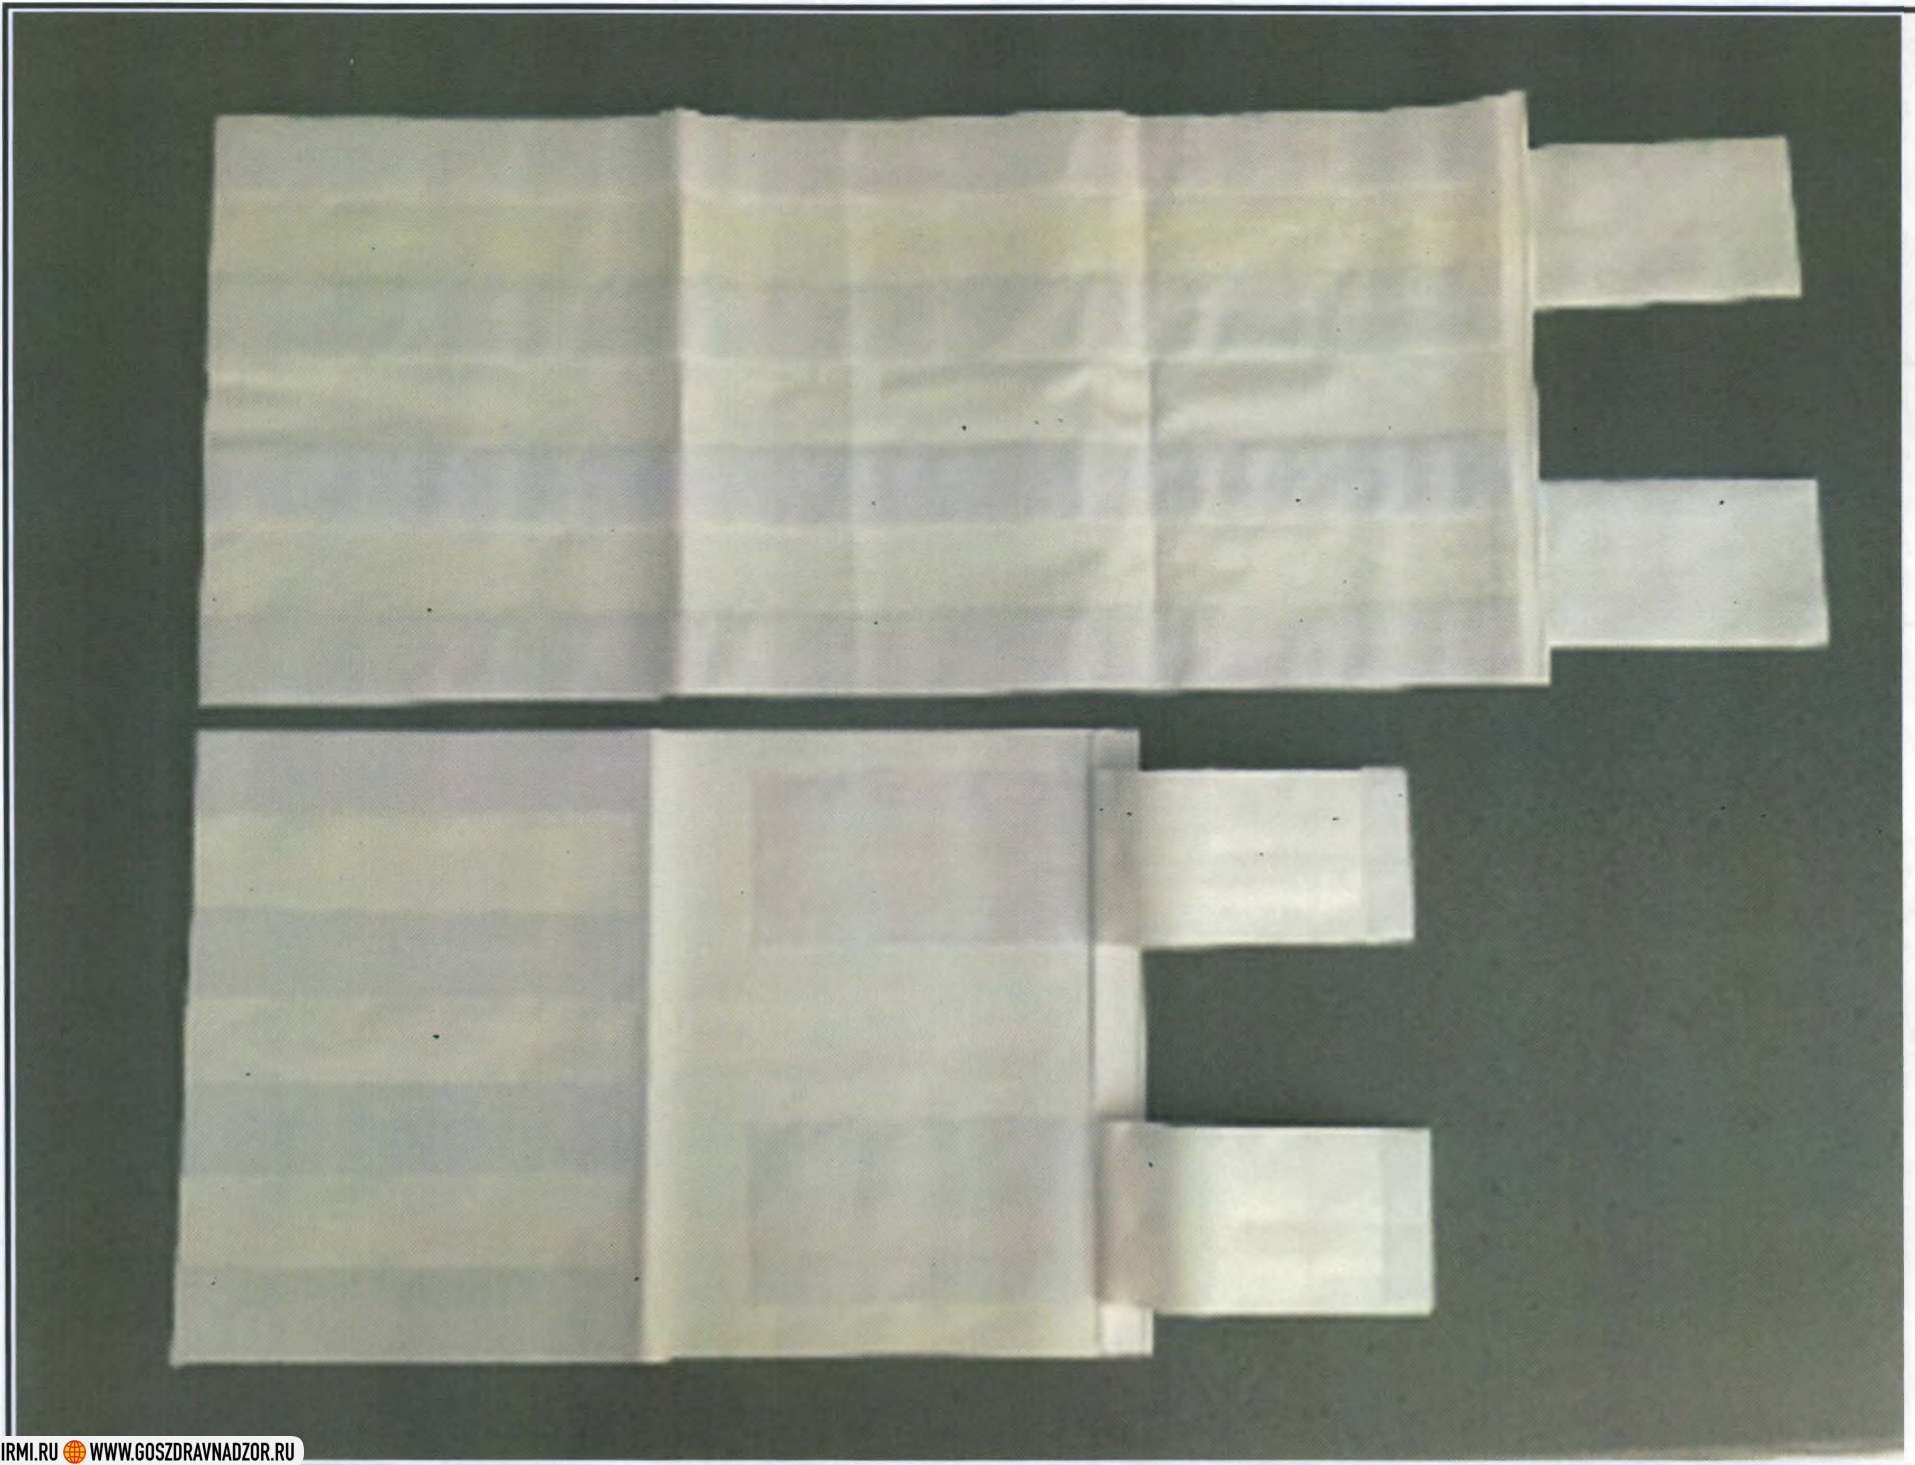


117. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).

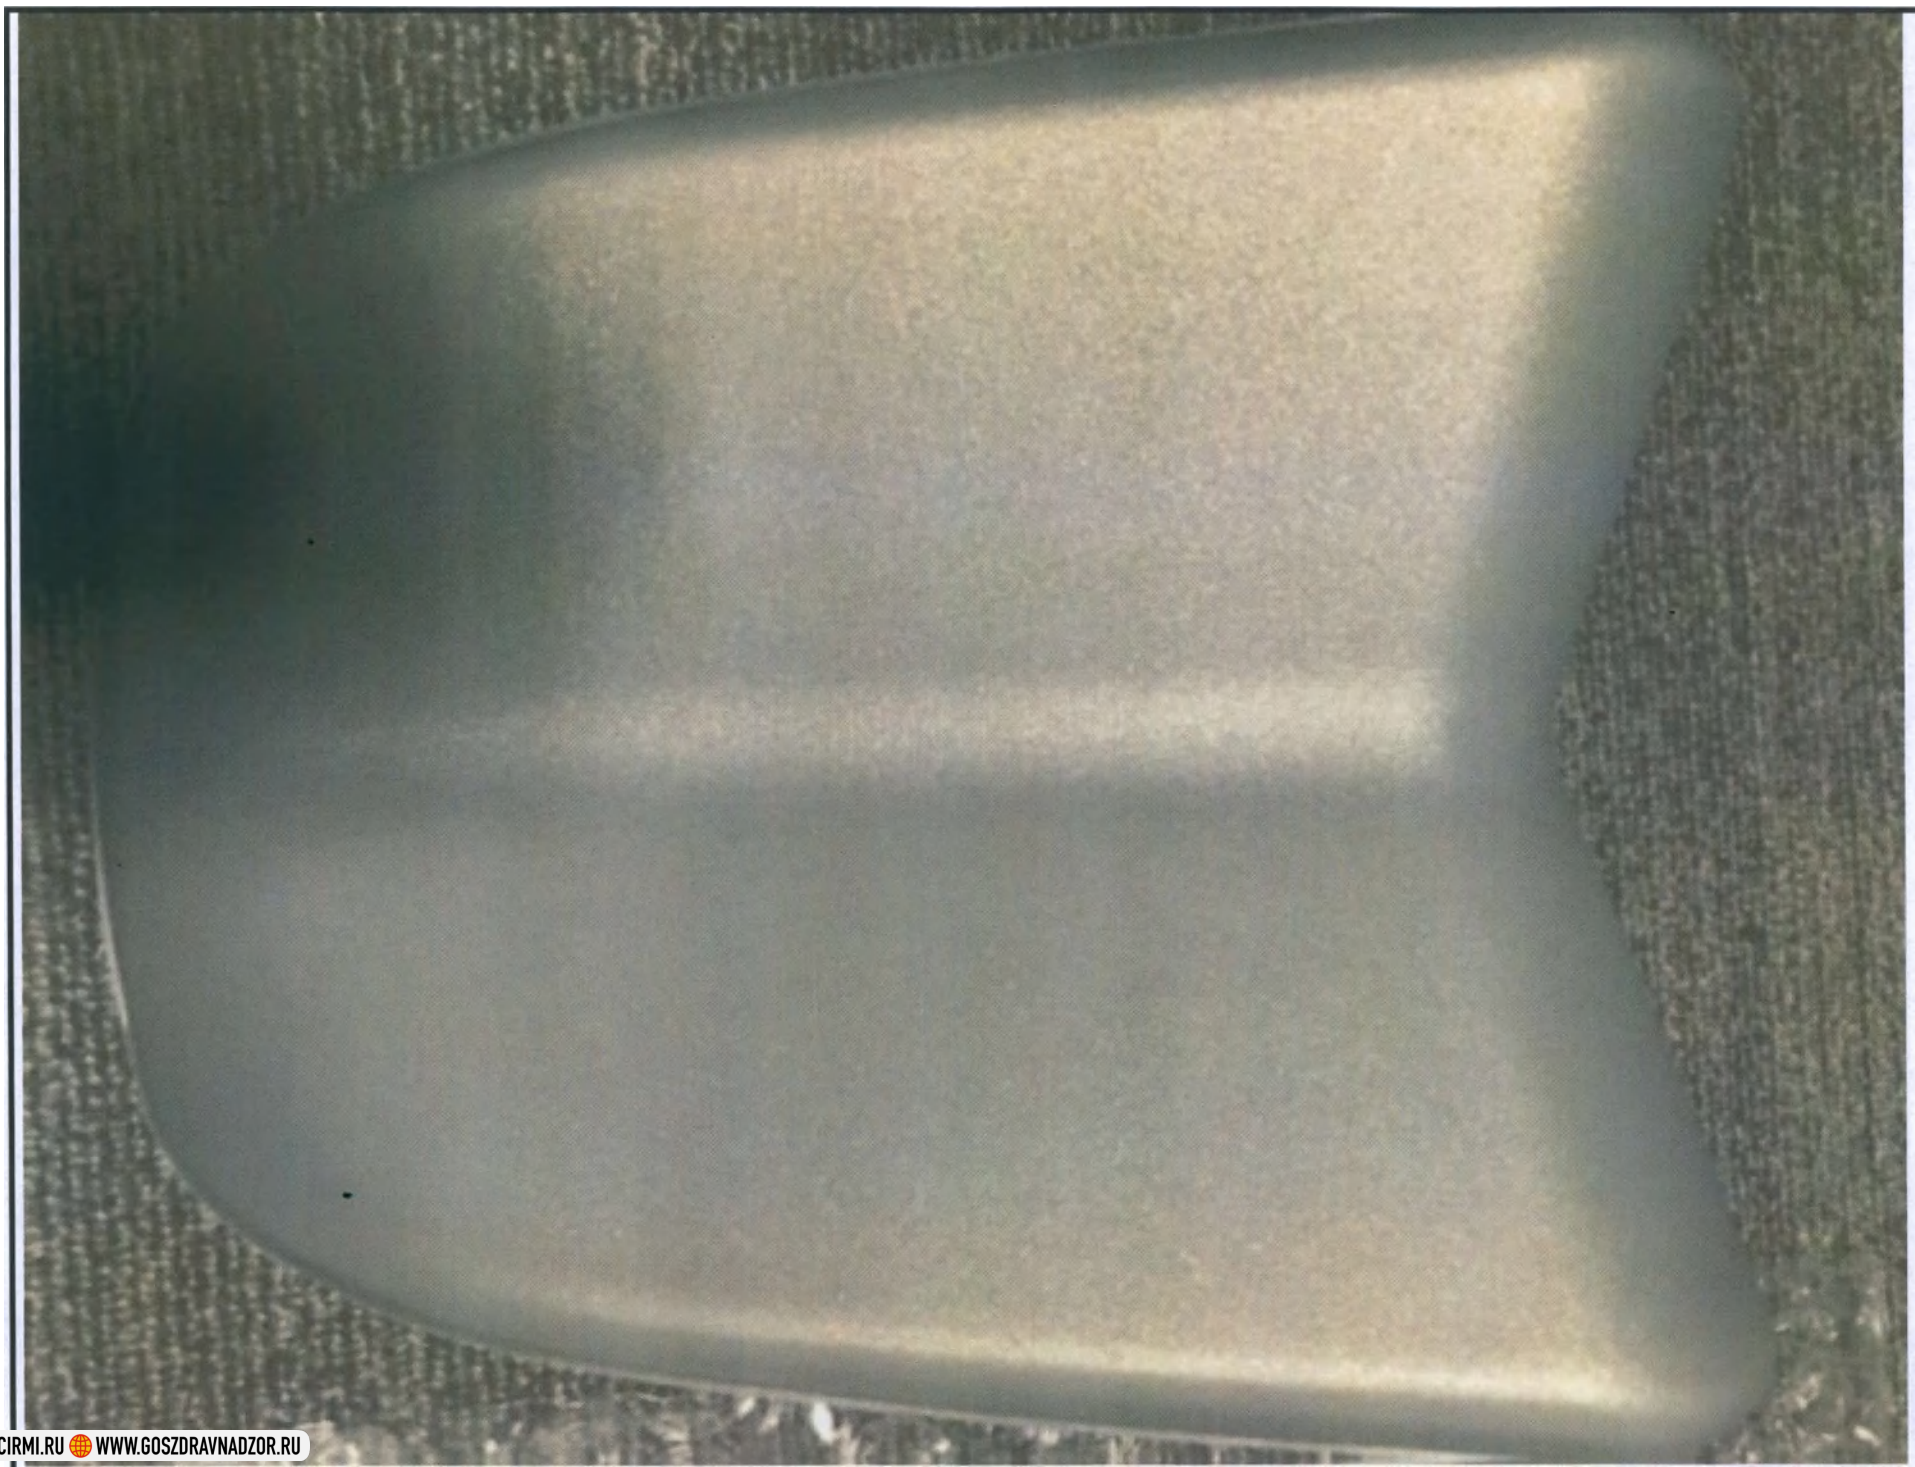


117. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).

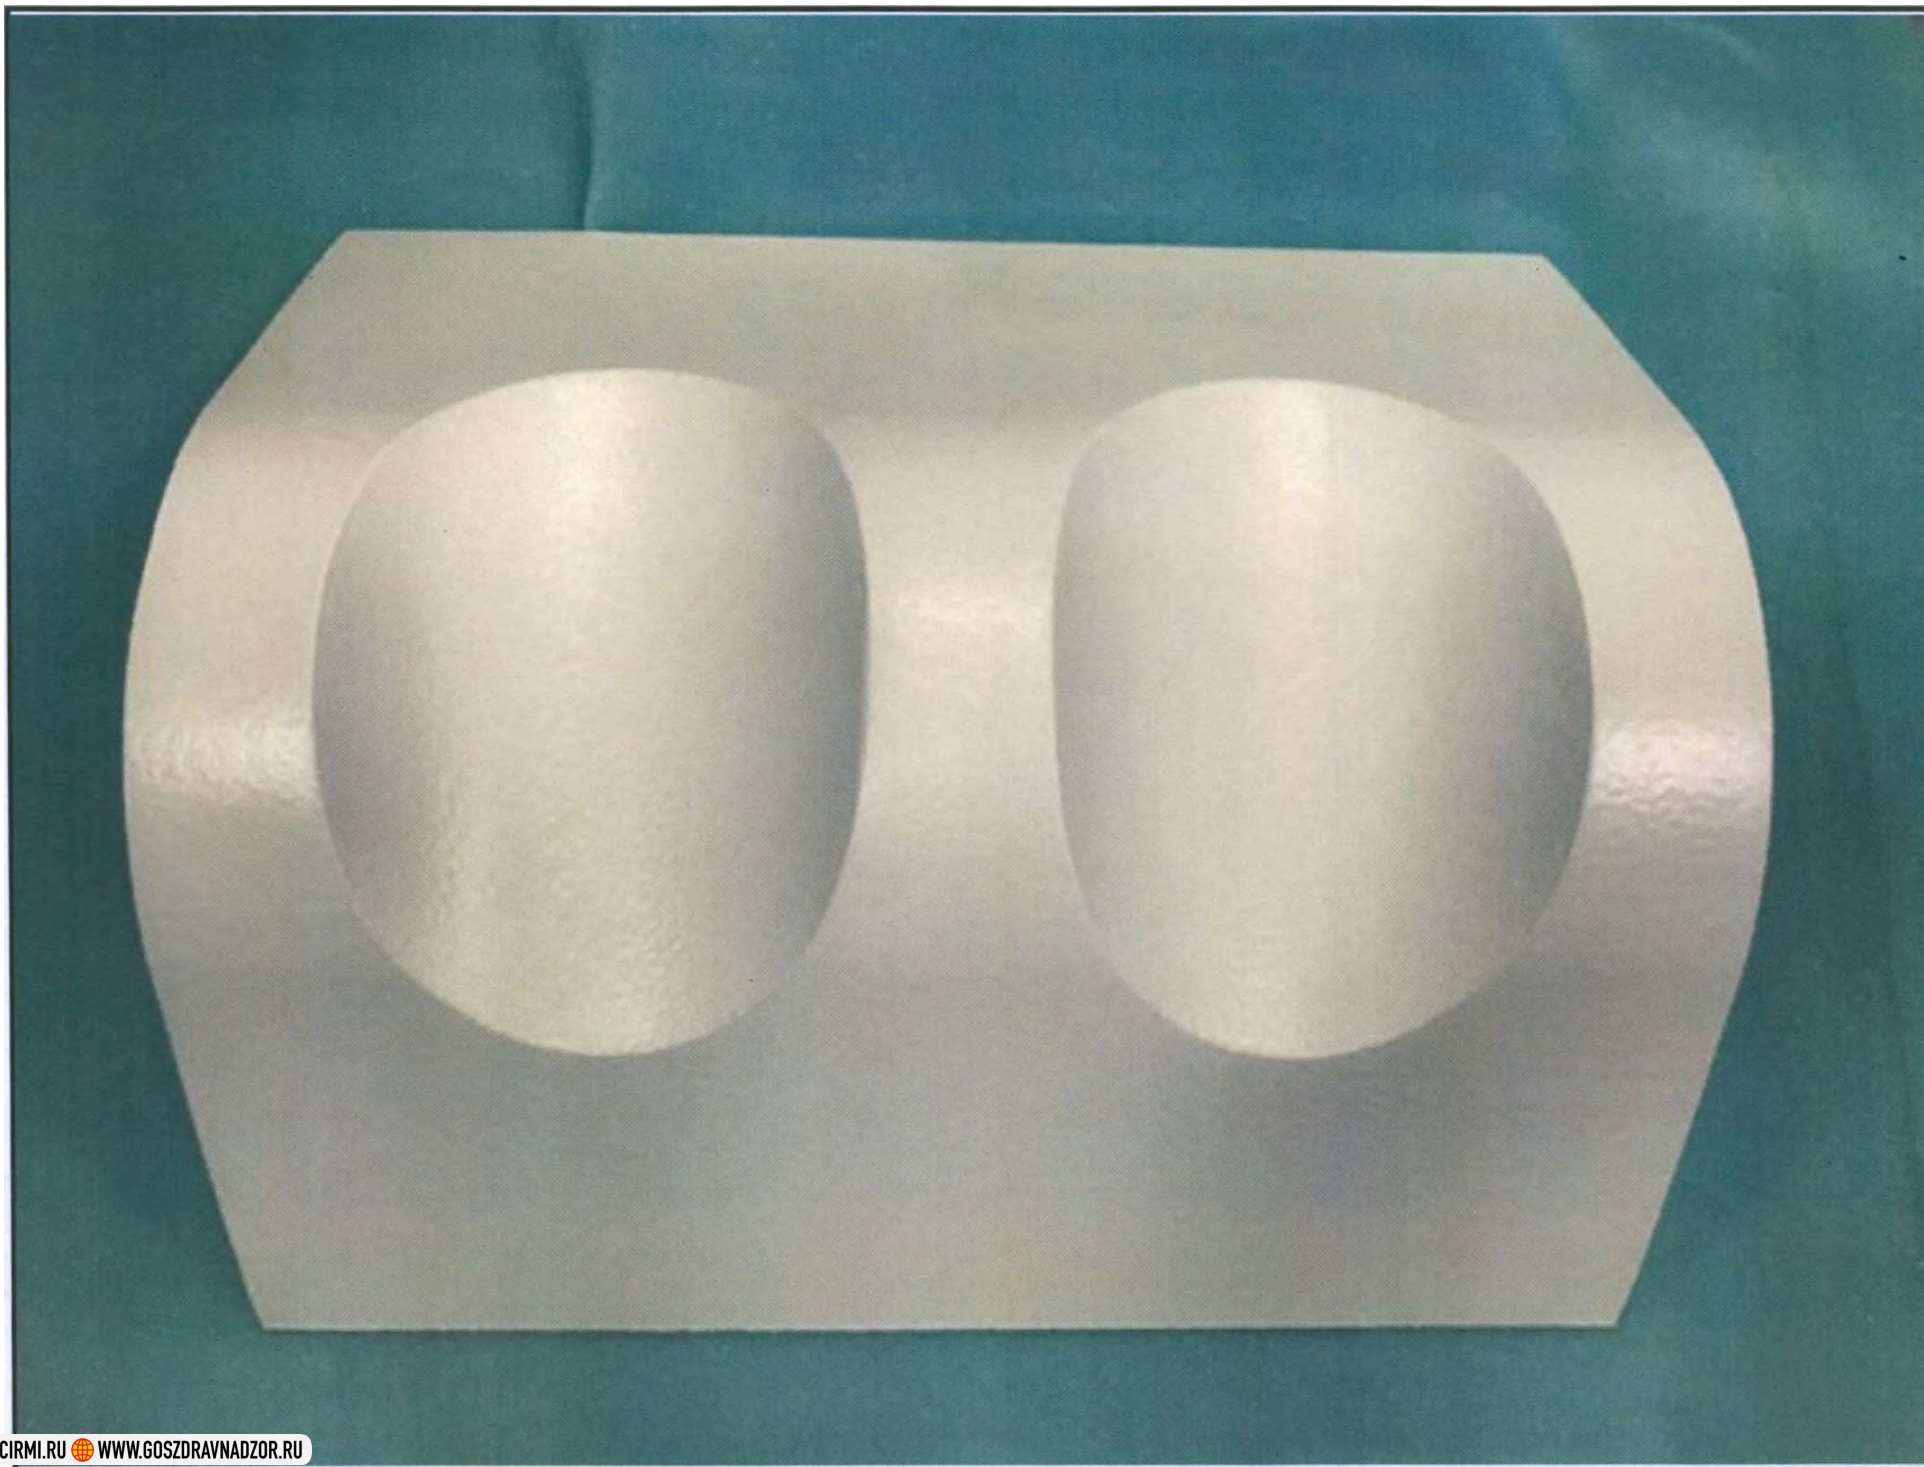

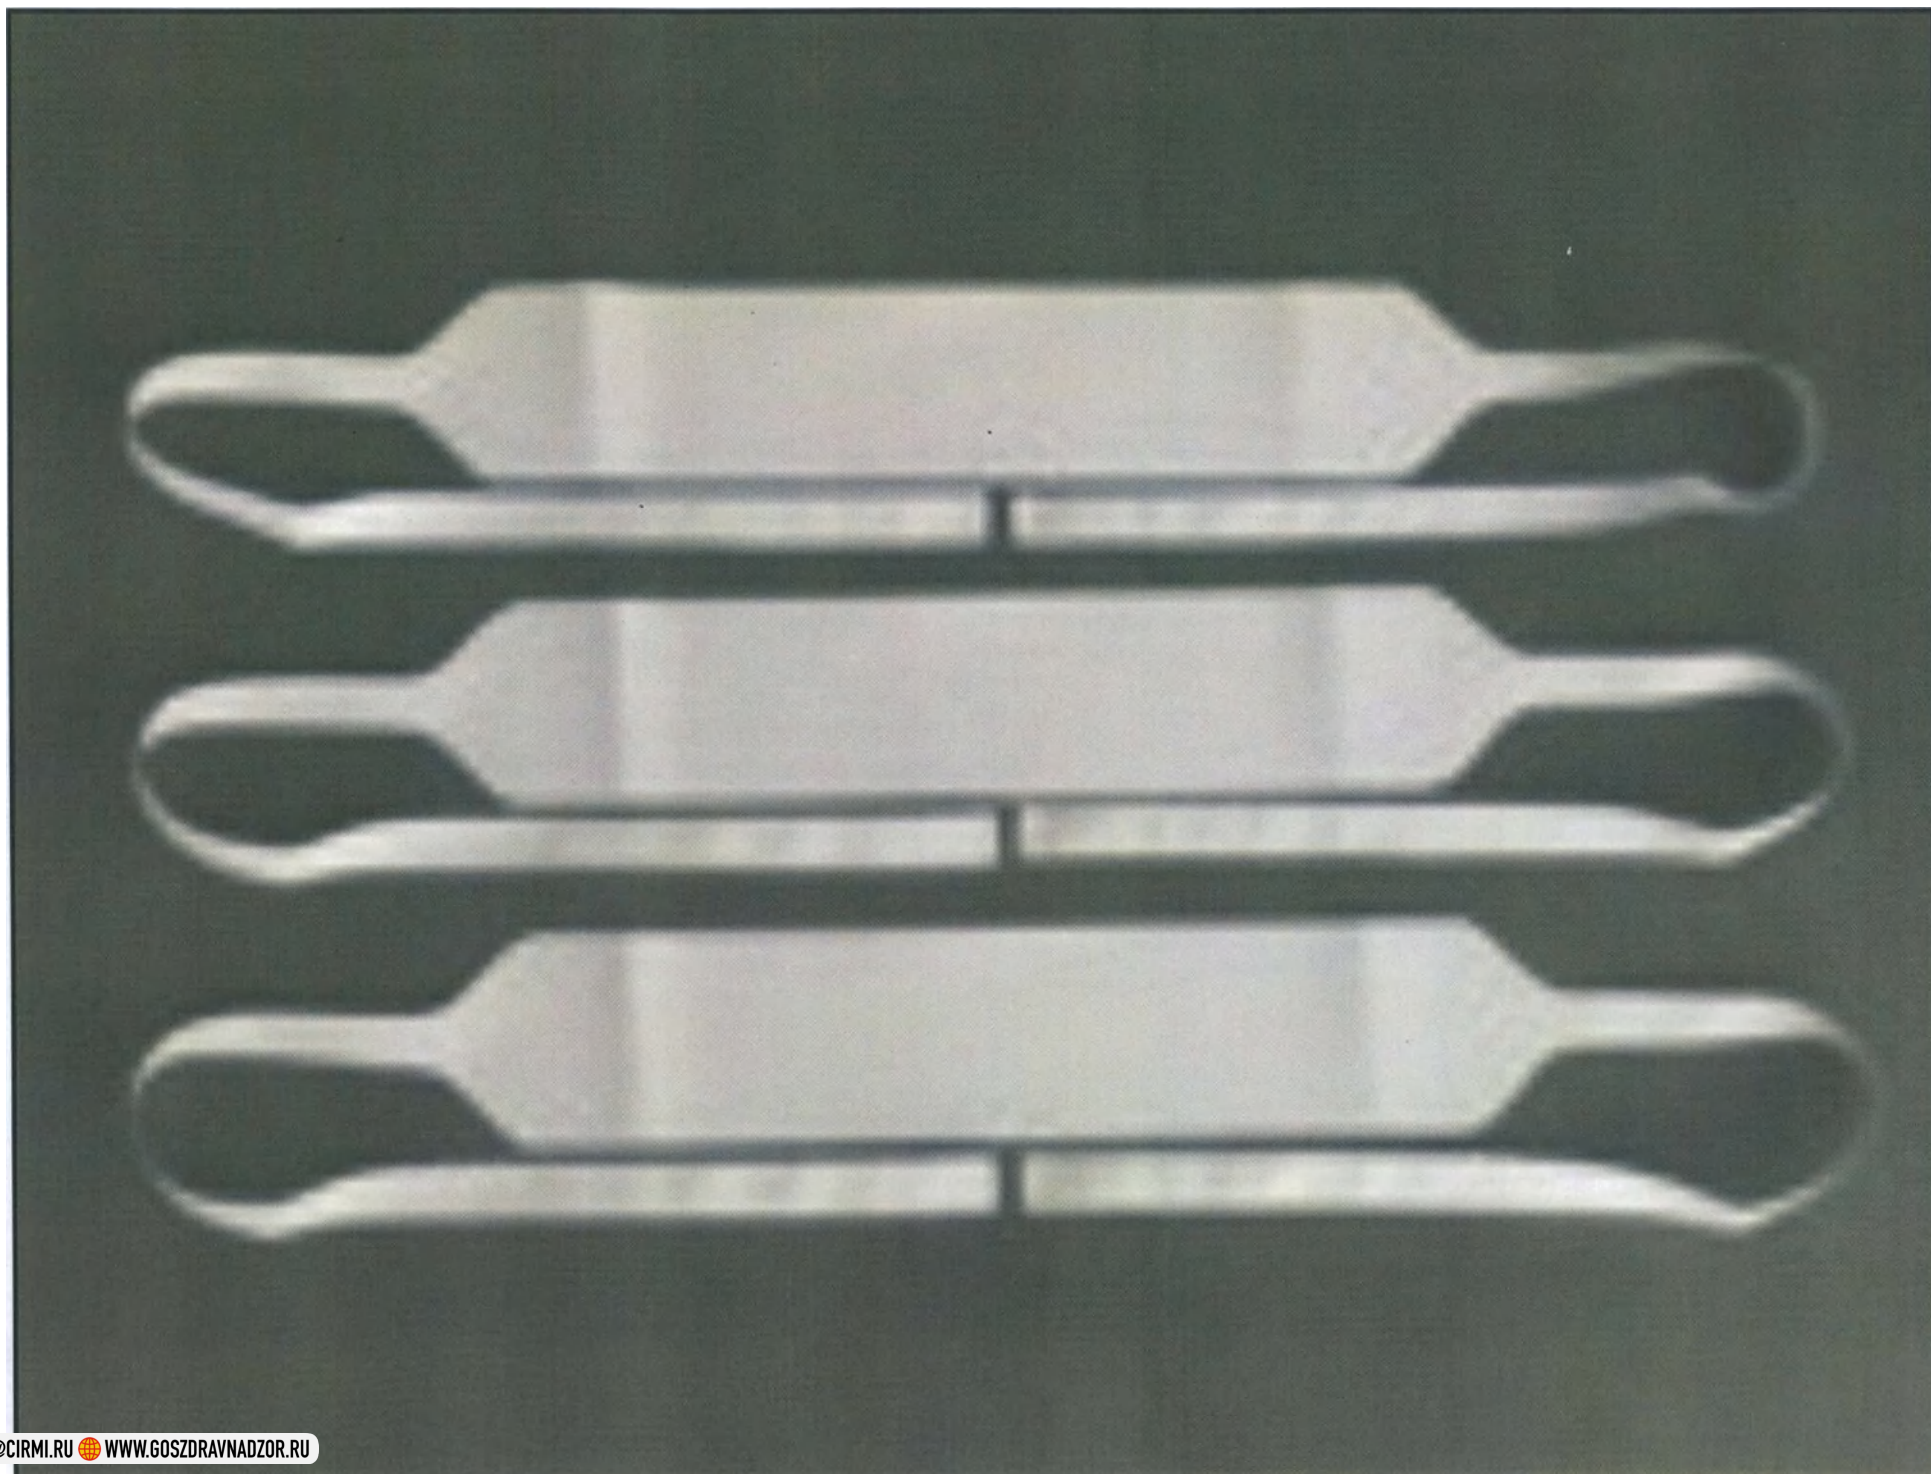



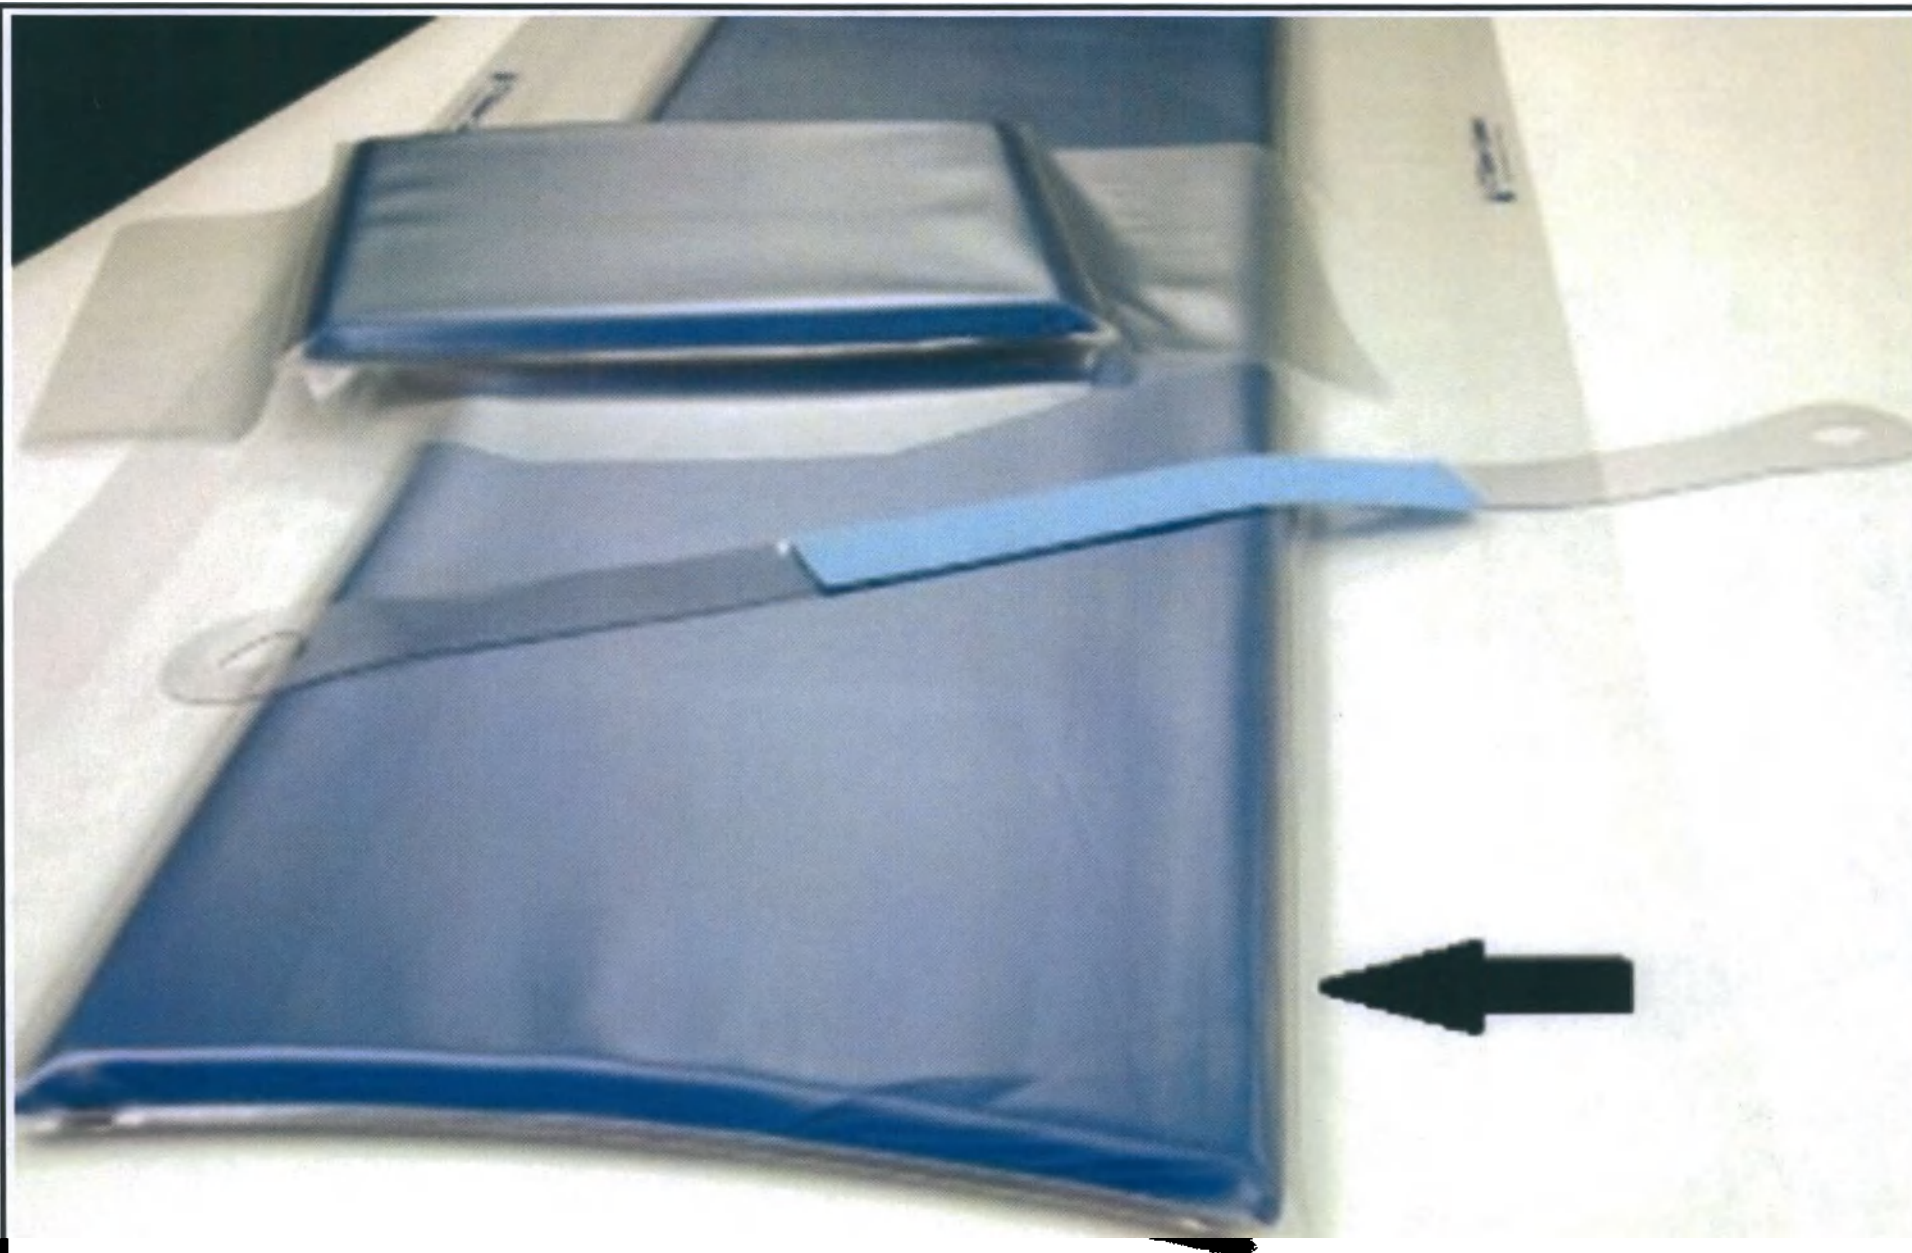




122. Подлокотники для инъекций (не более 5 шт.).







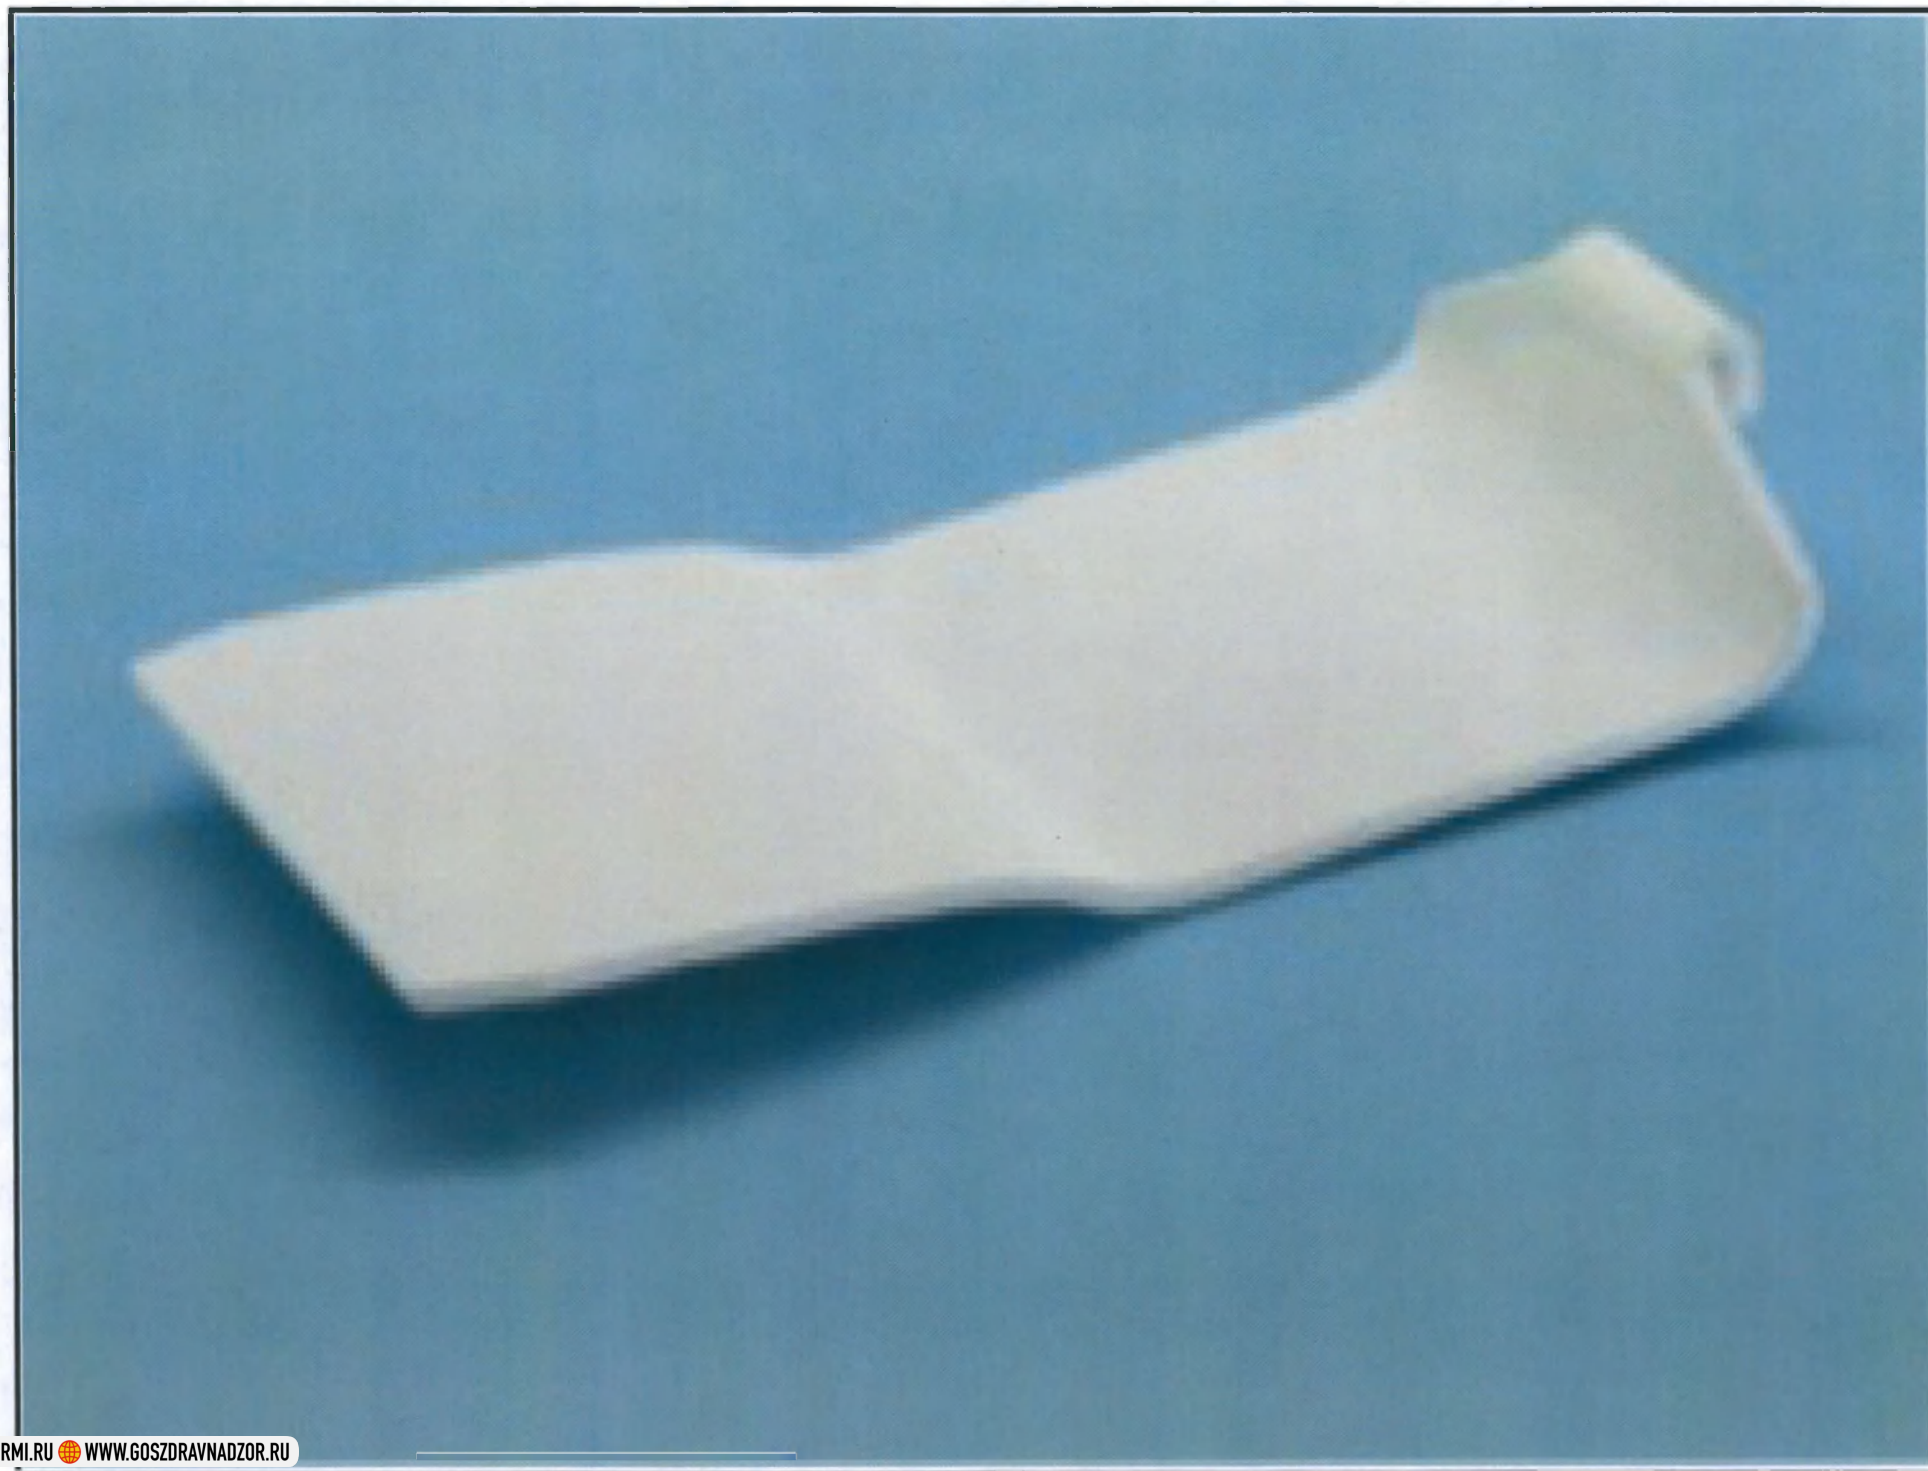

125. Специальный шкаф для хранения принадлежностей.




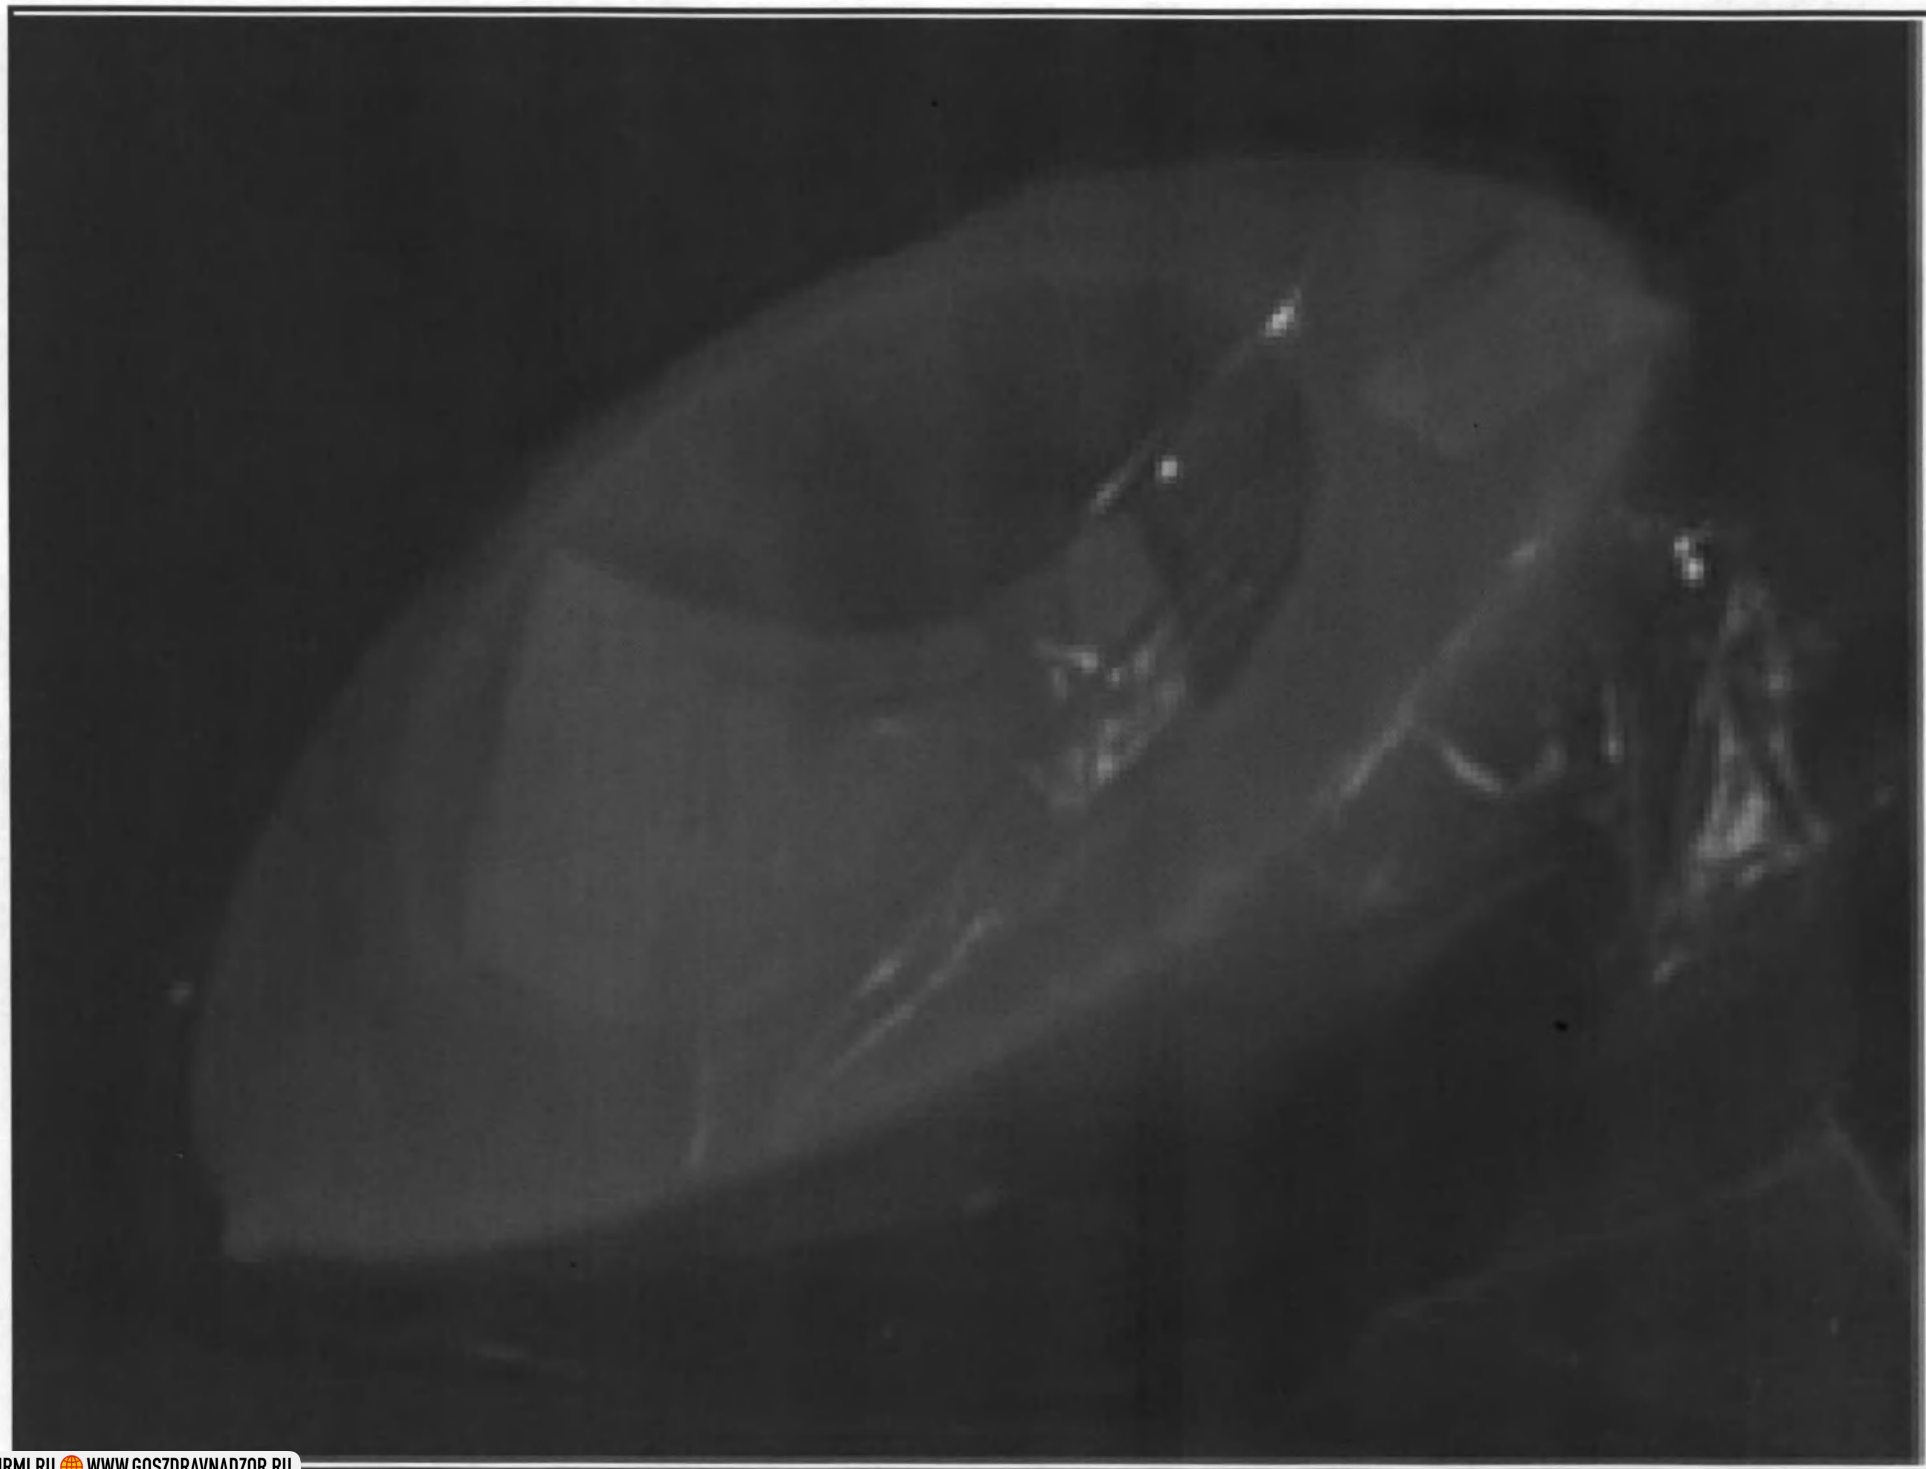

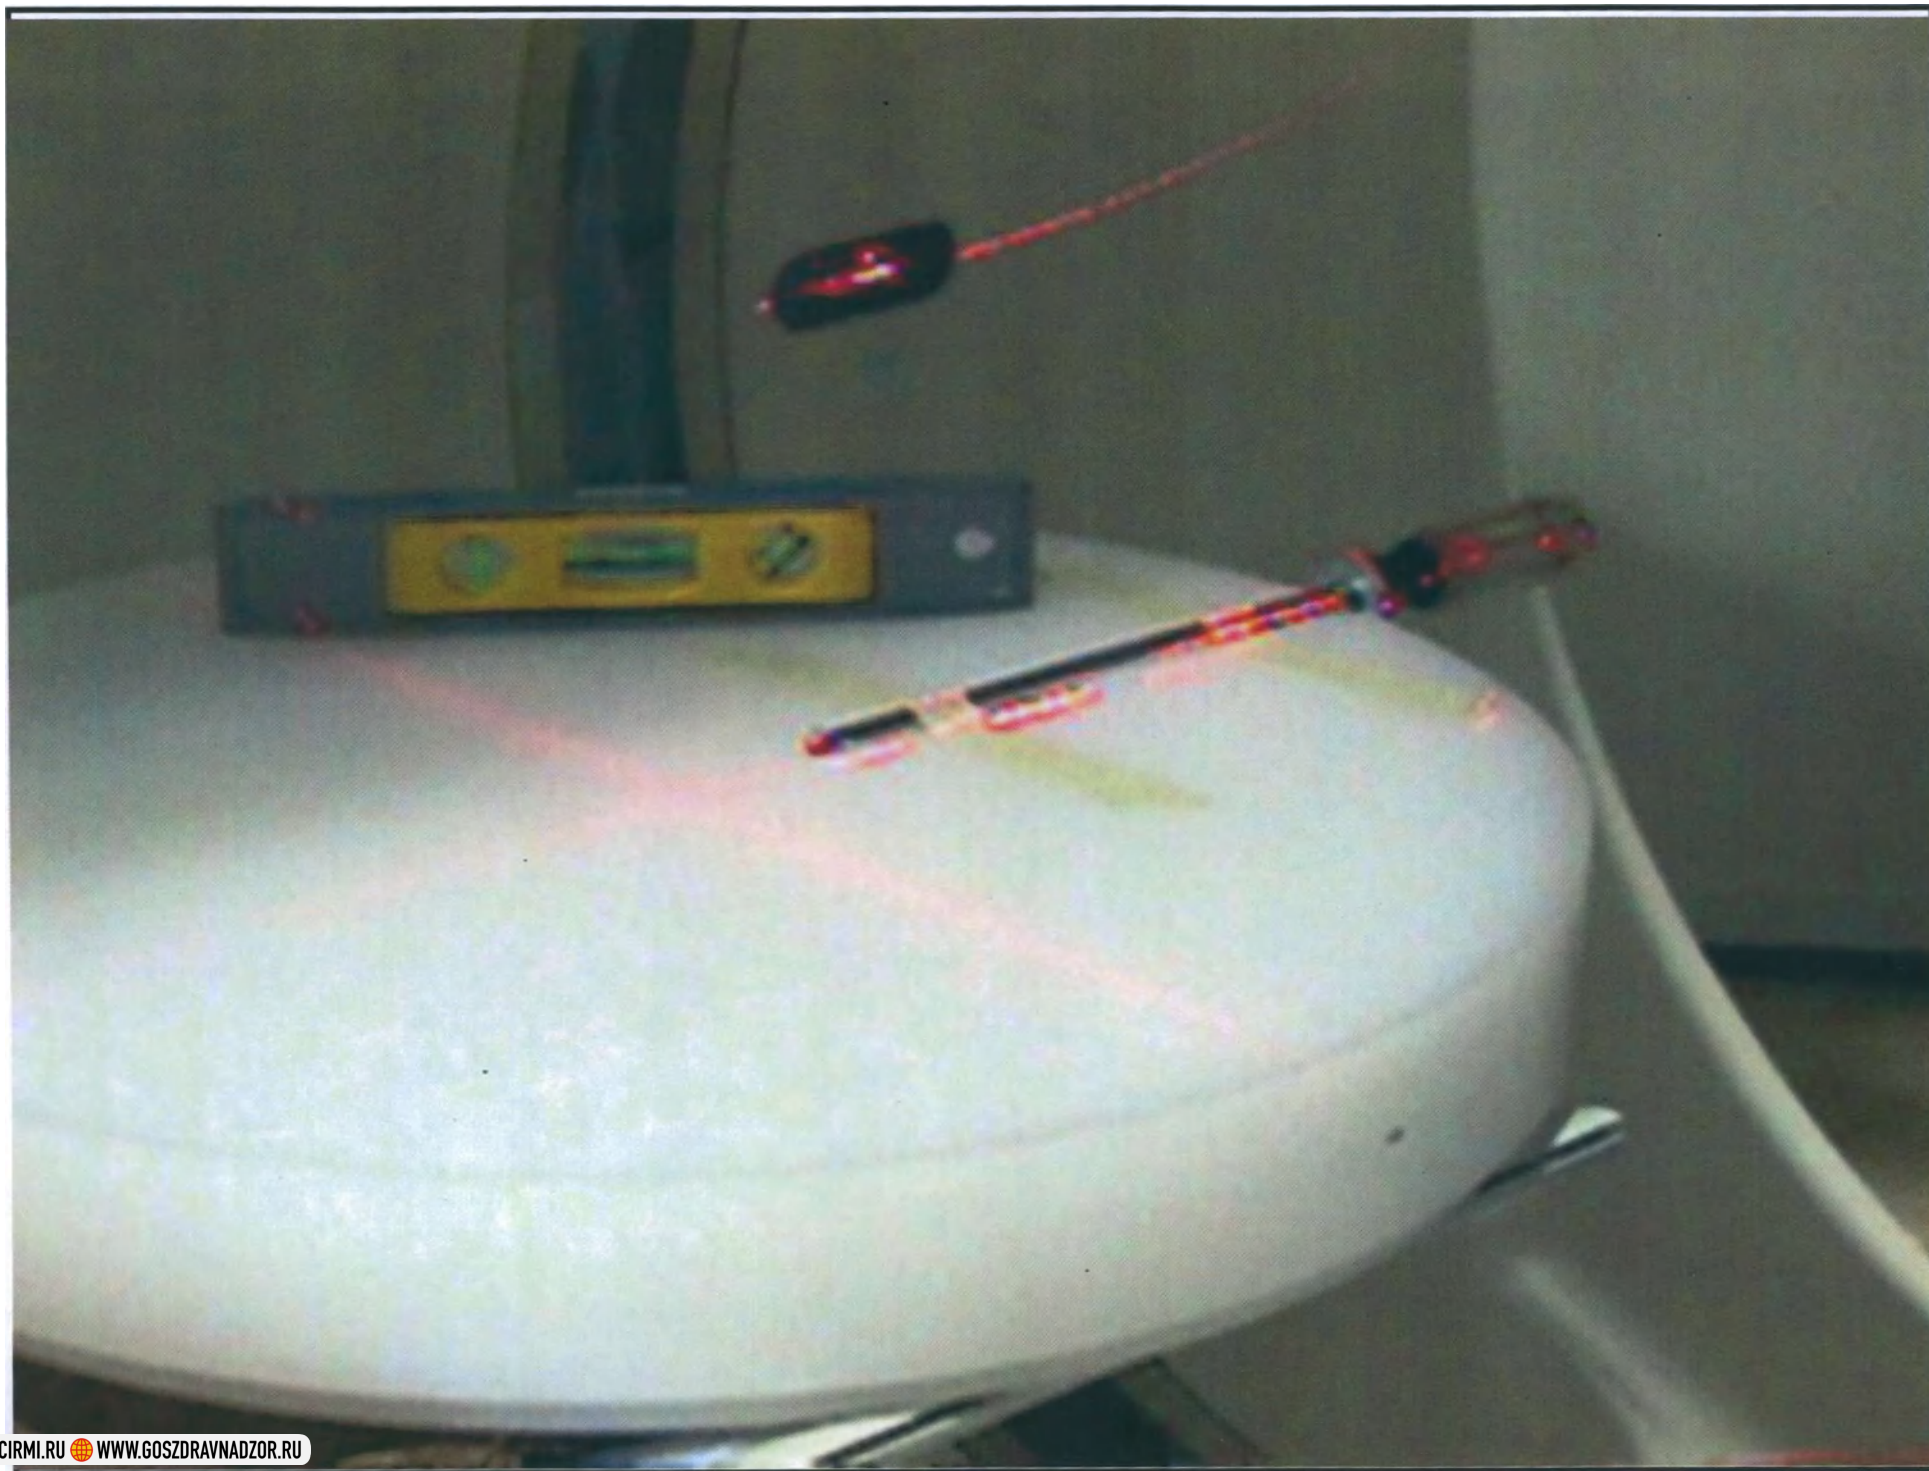







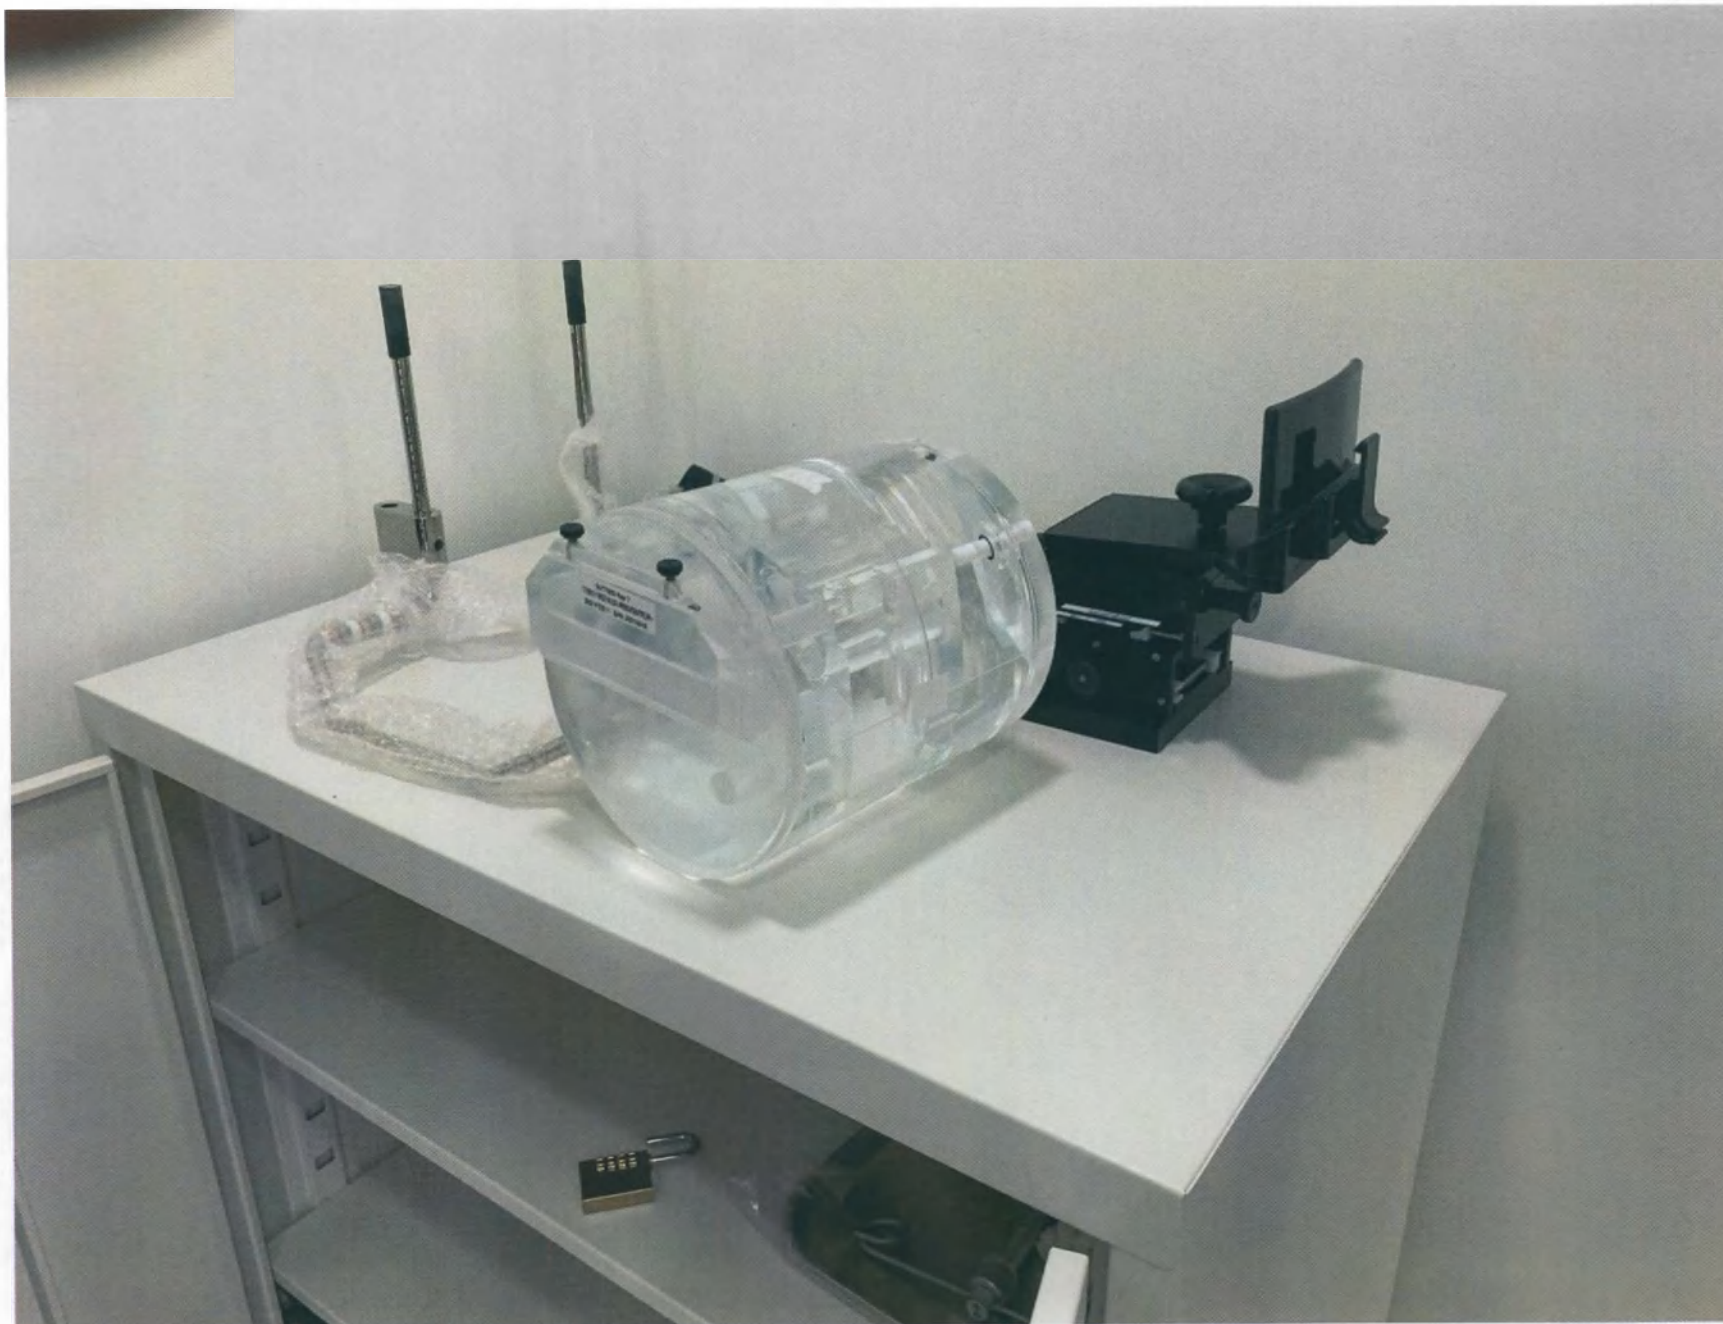





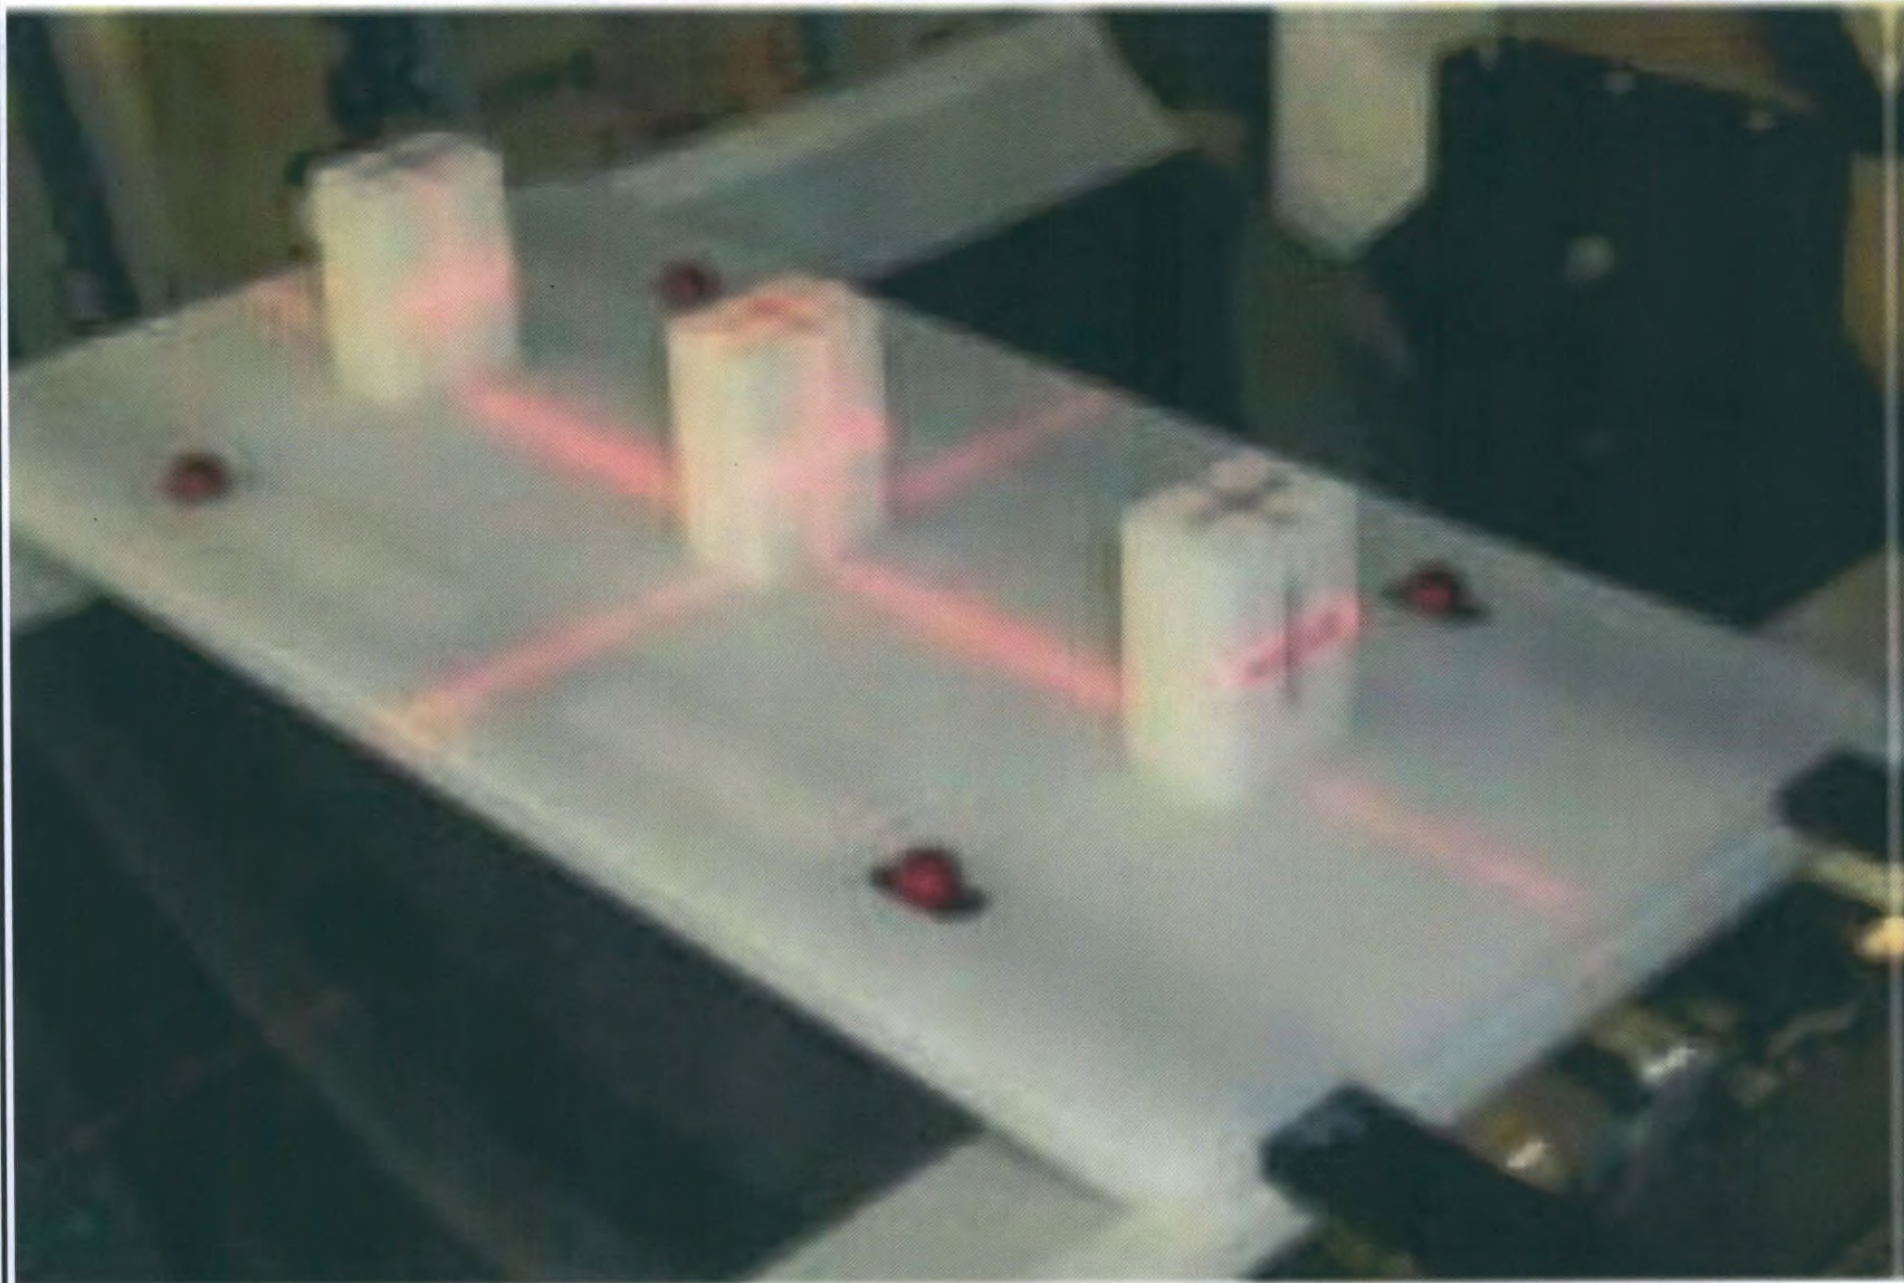


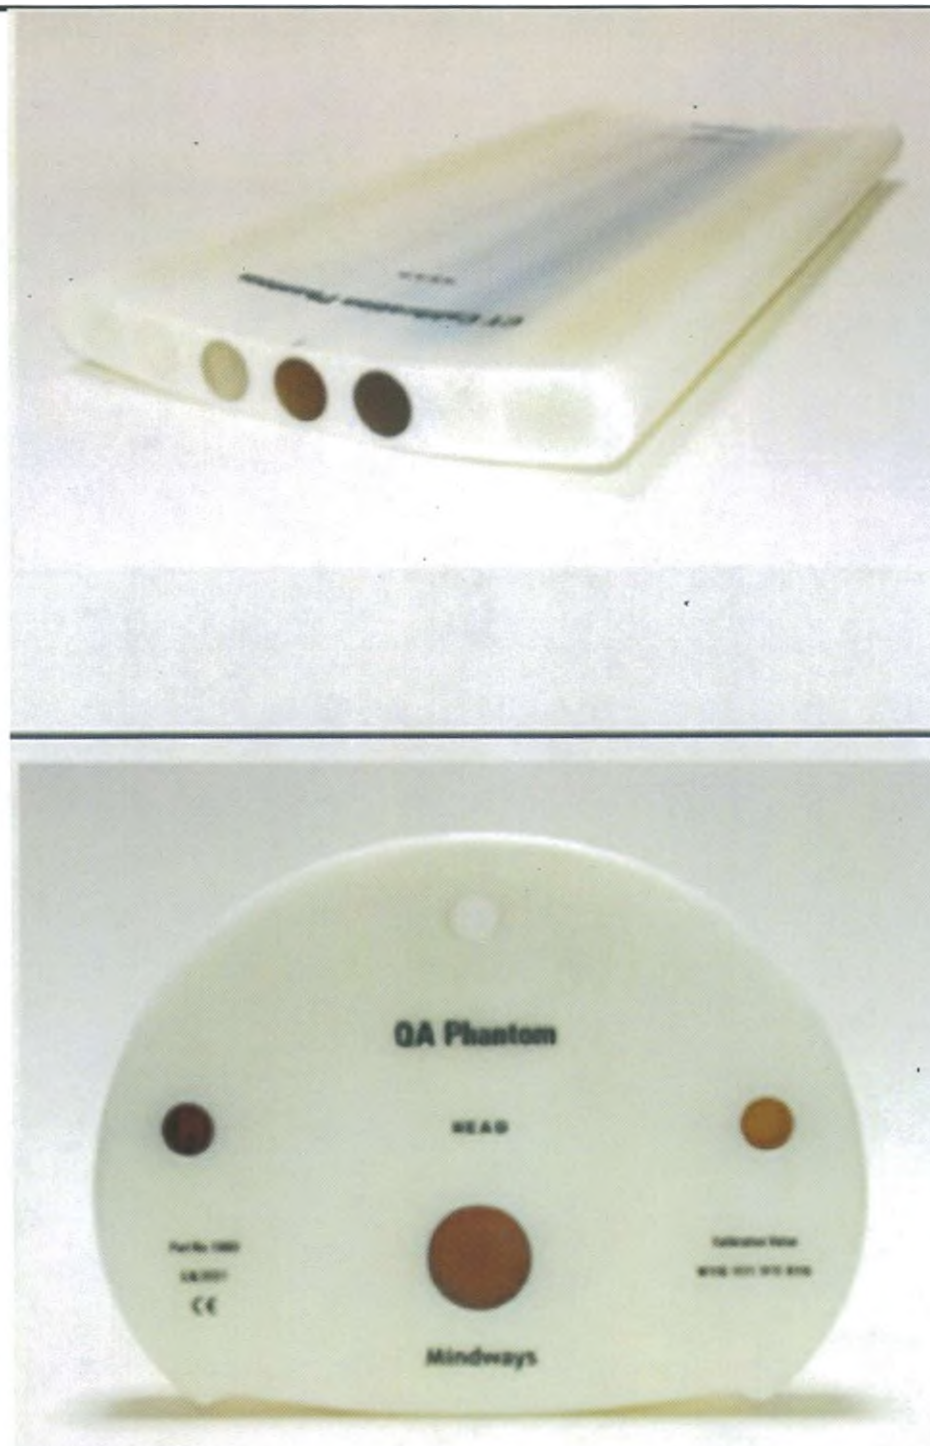

127. Фантомы контроля качества рентгеновского изображения (не более 5 шт.).

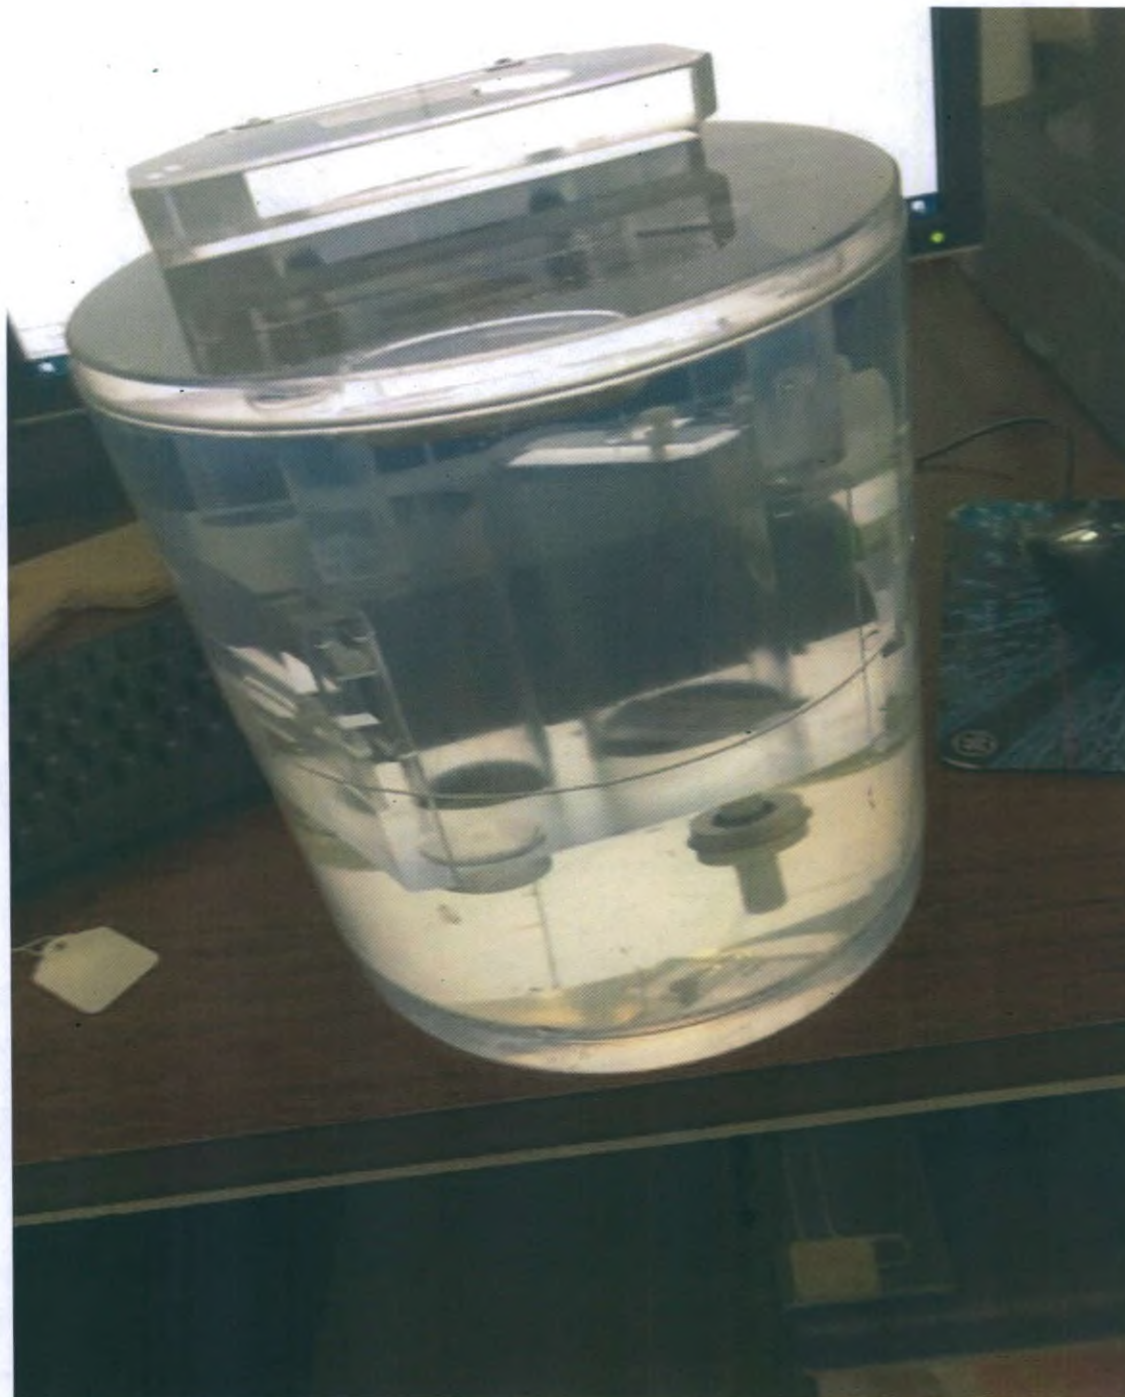


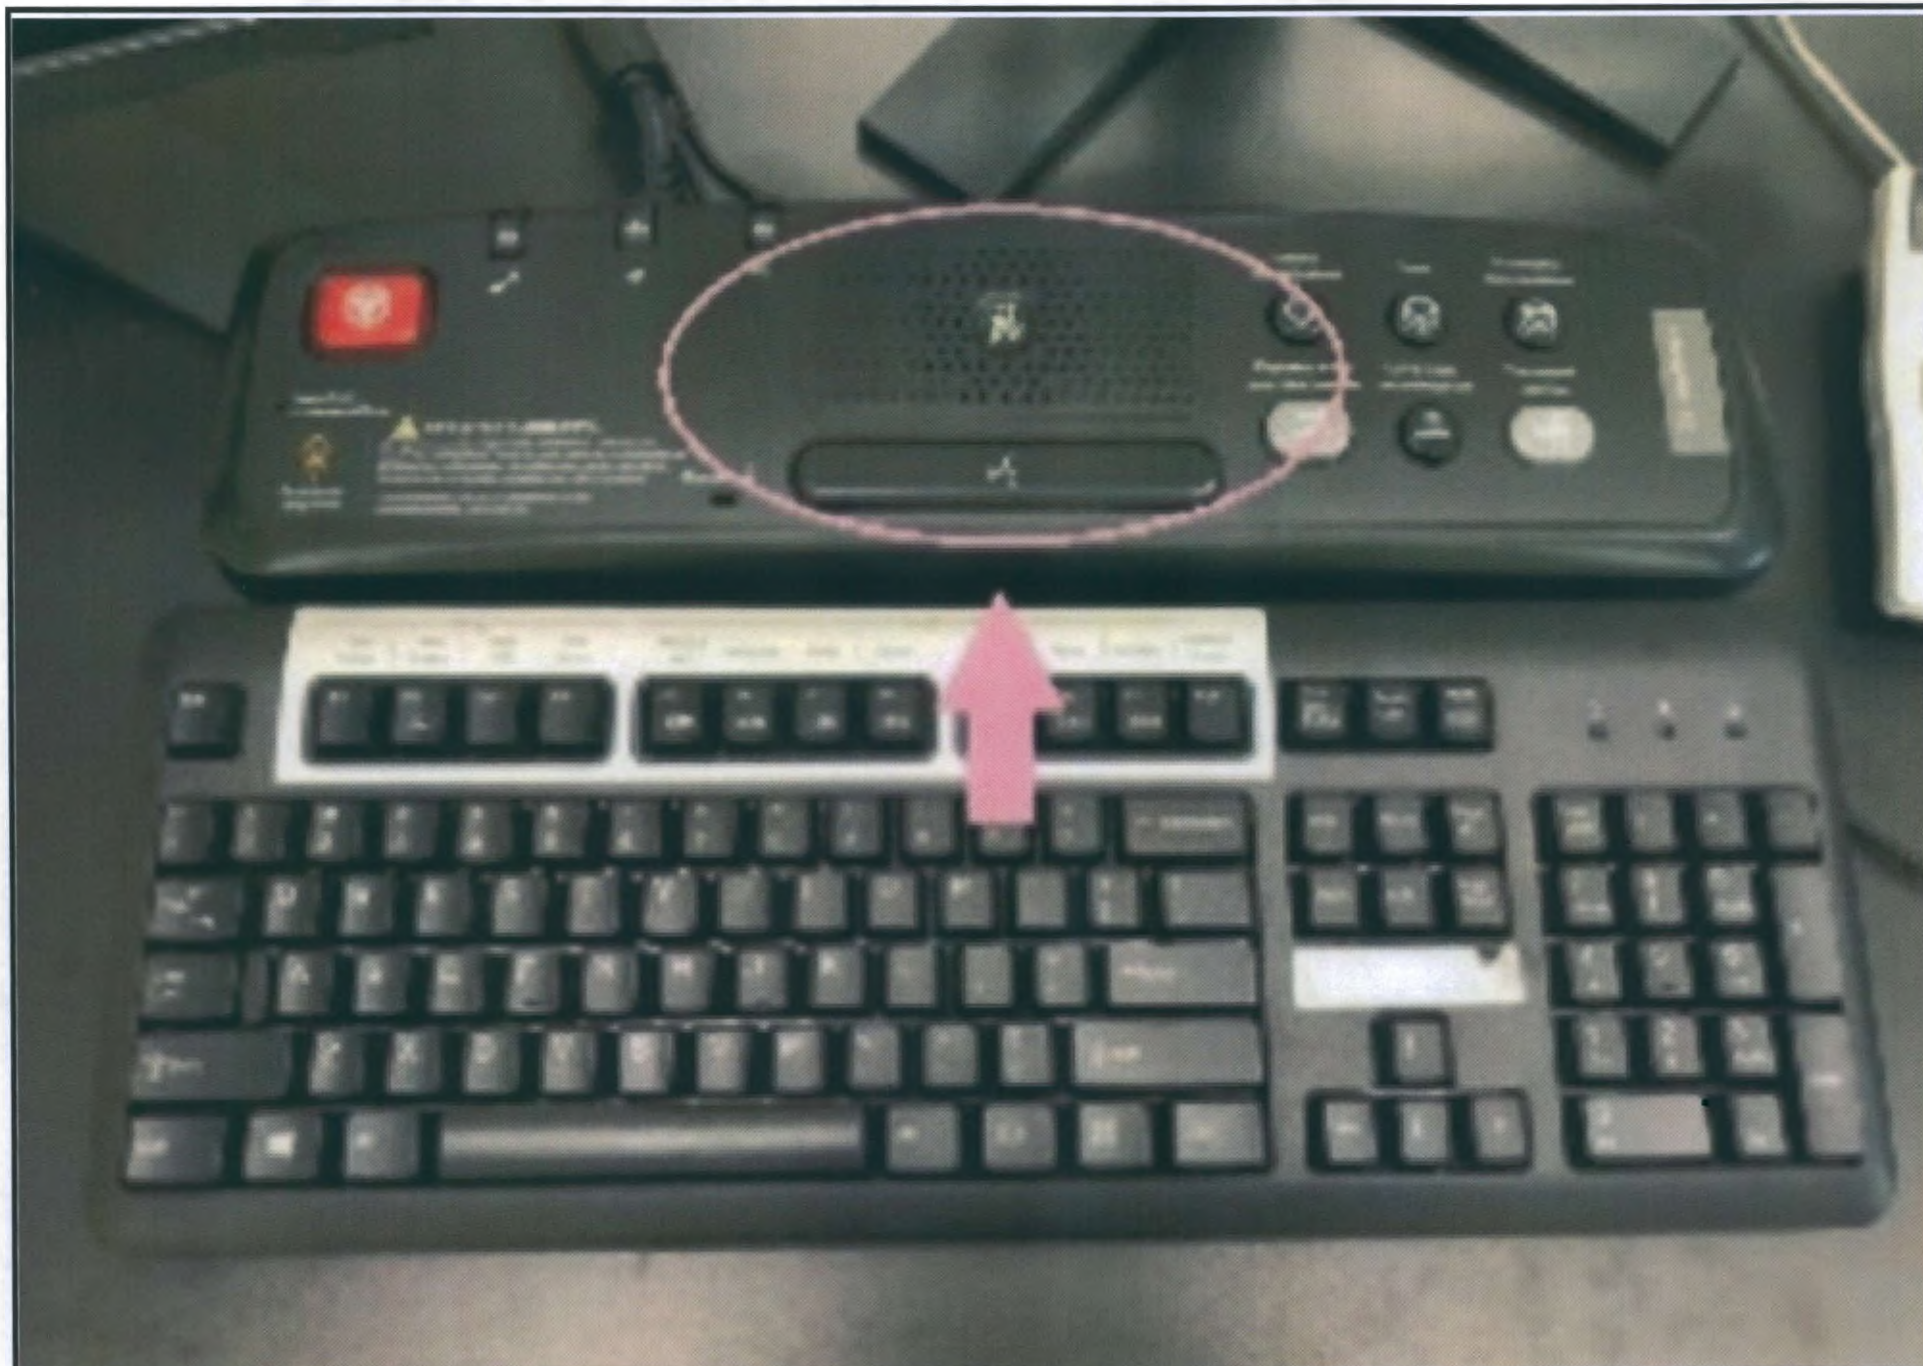

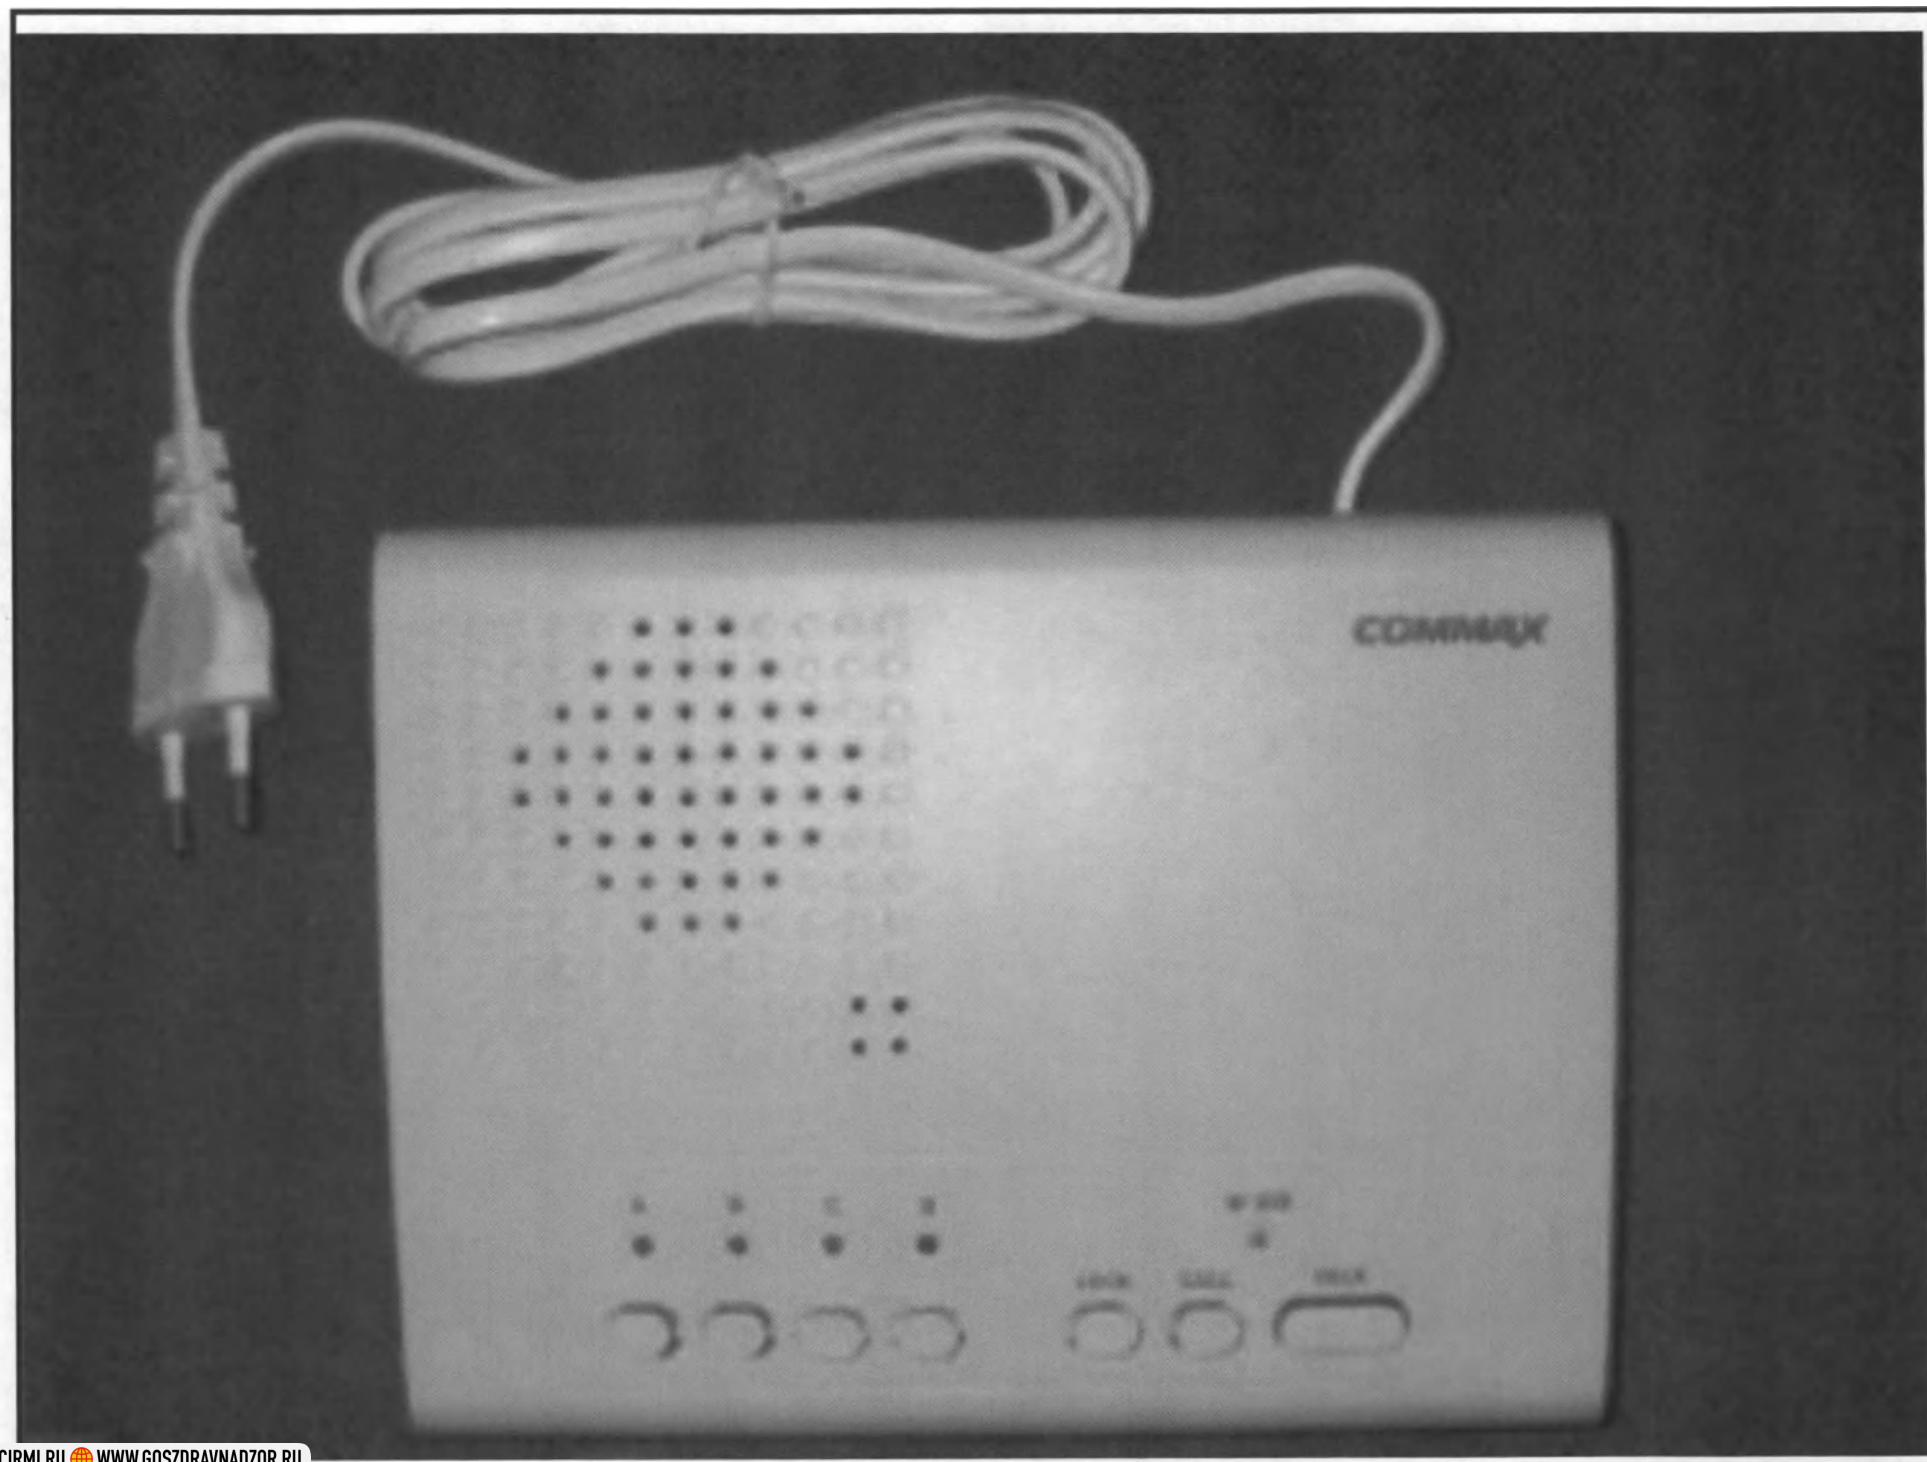


130. Кресла оператора (не более 2 шт.).



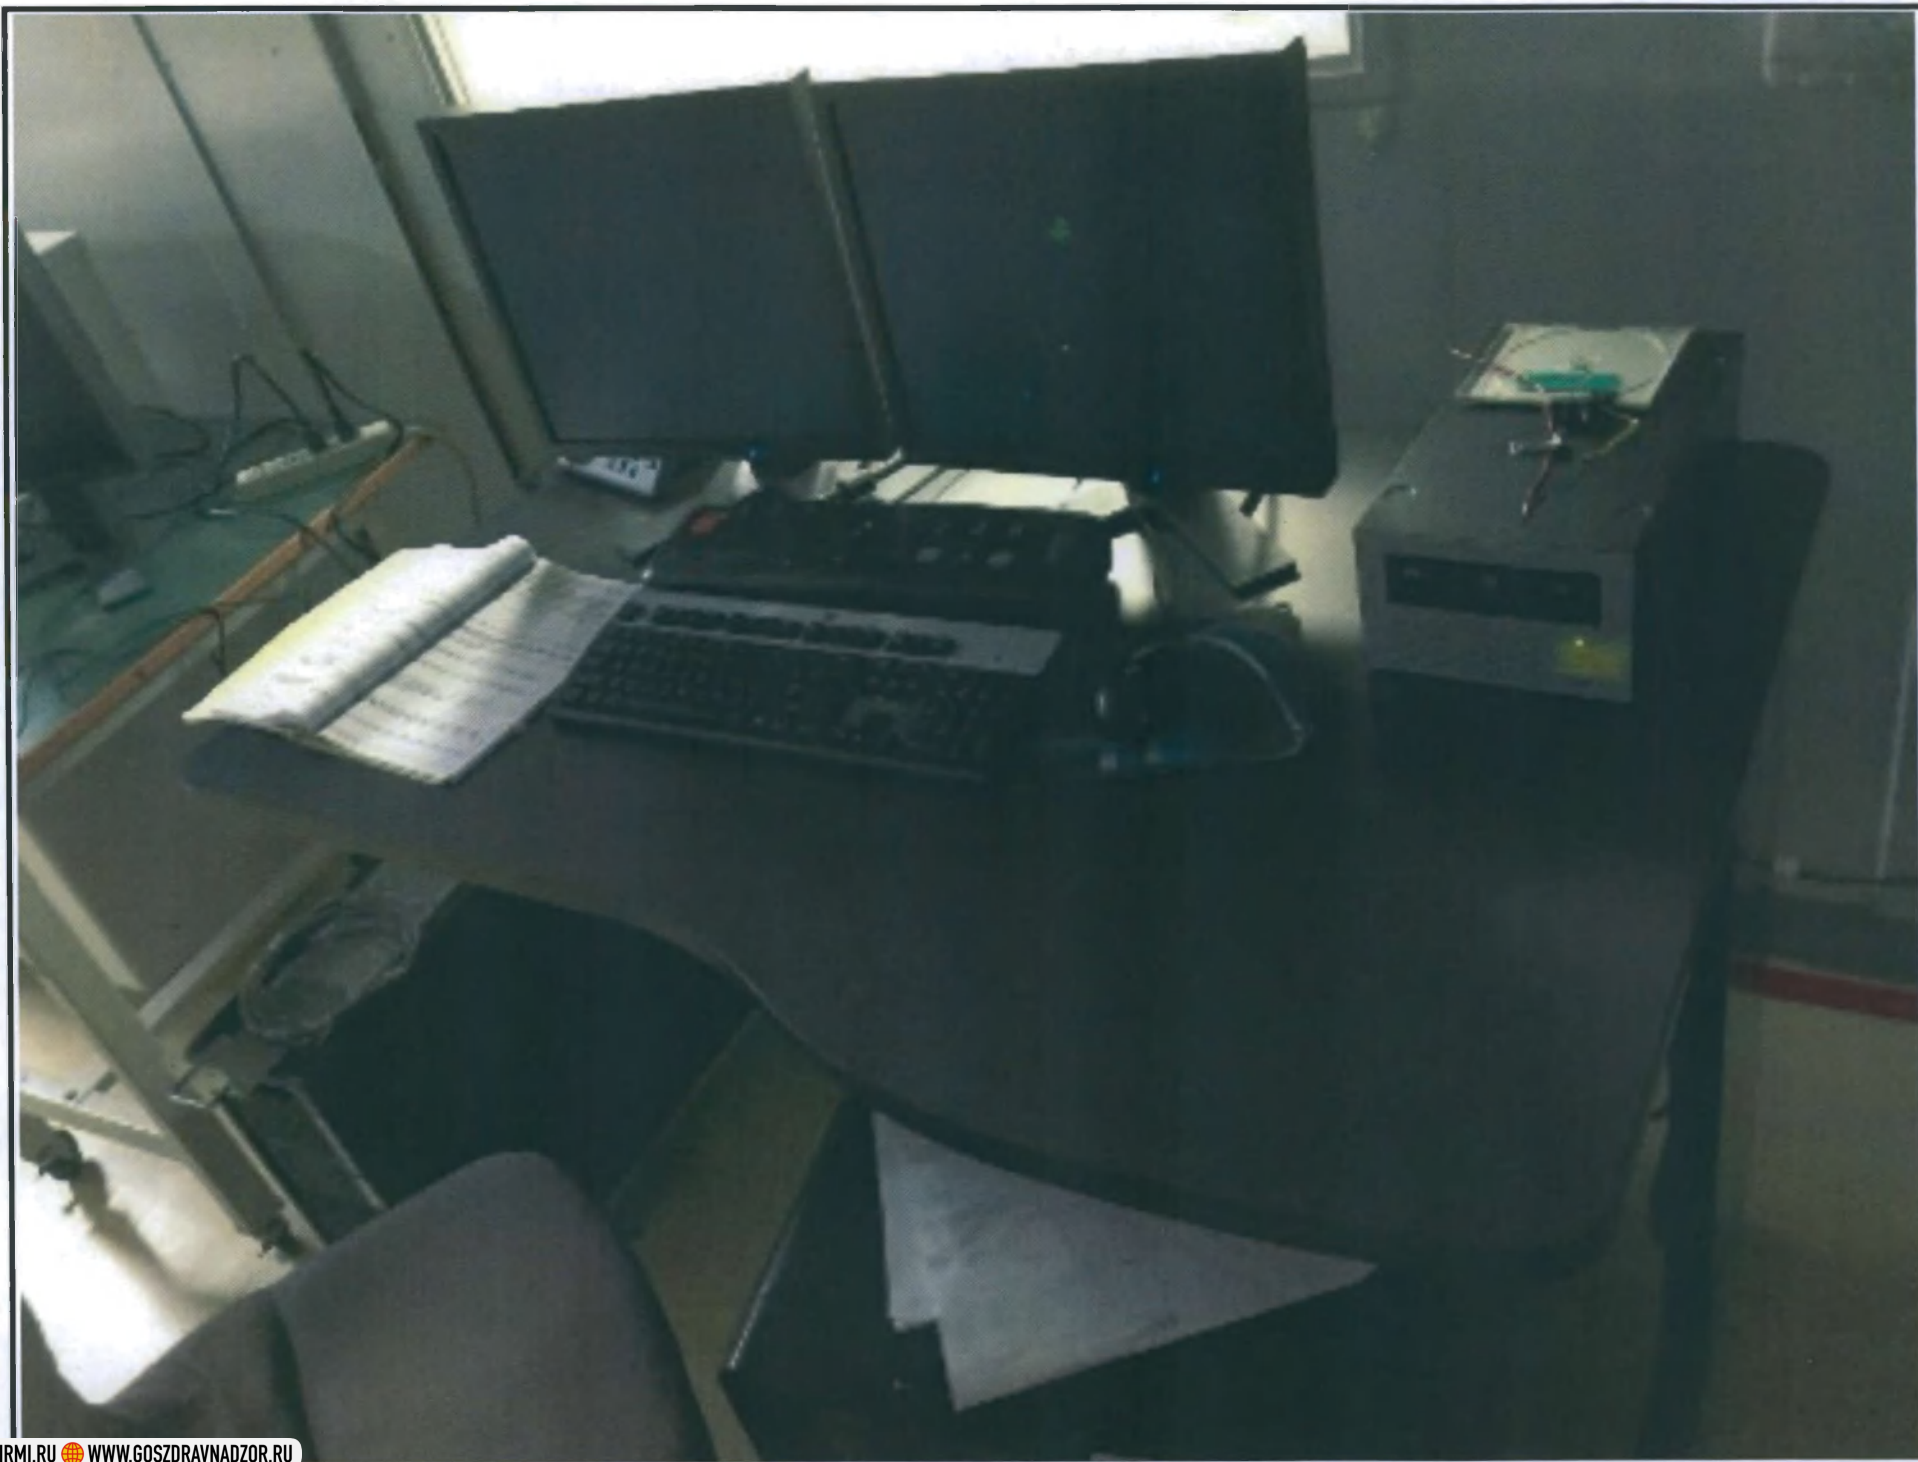

132. Устройство считывания штриховых кодов карт пациентов.

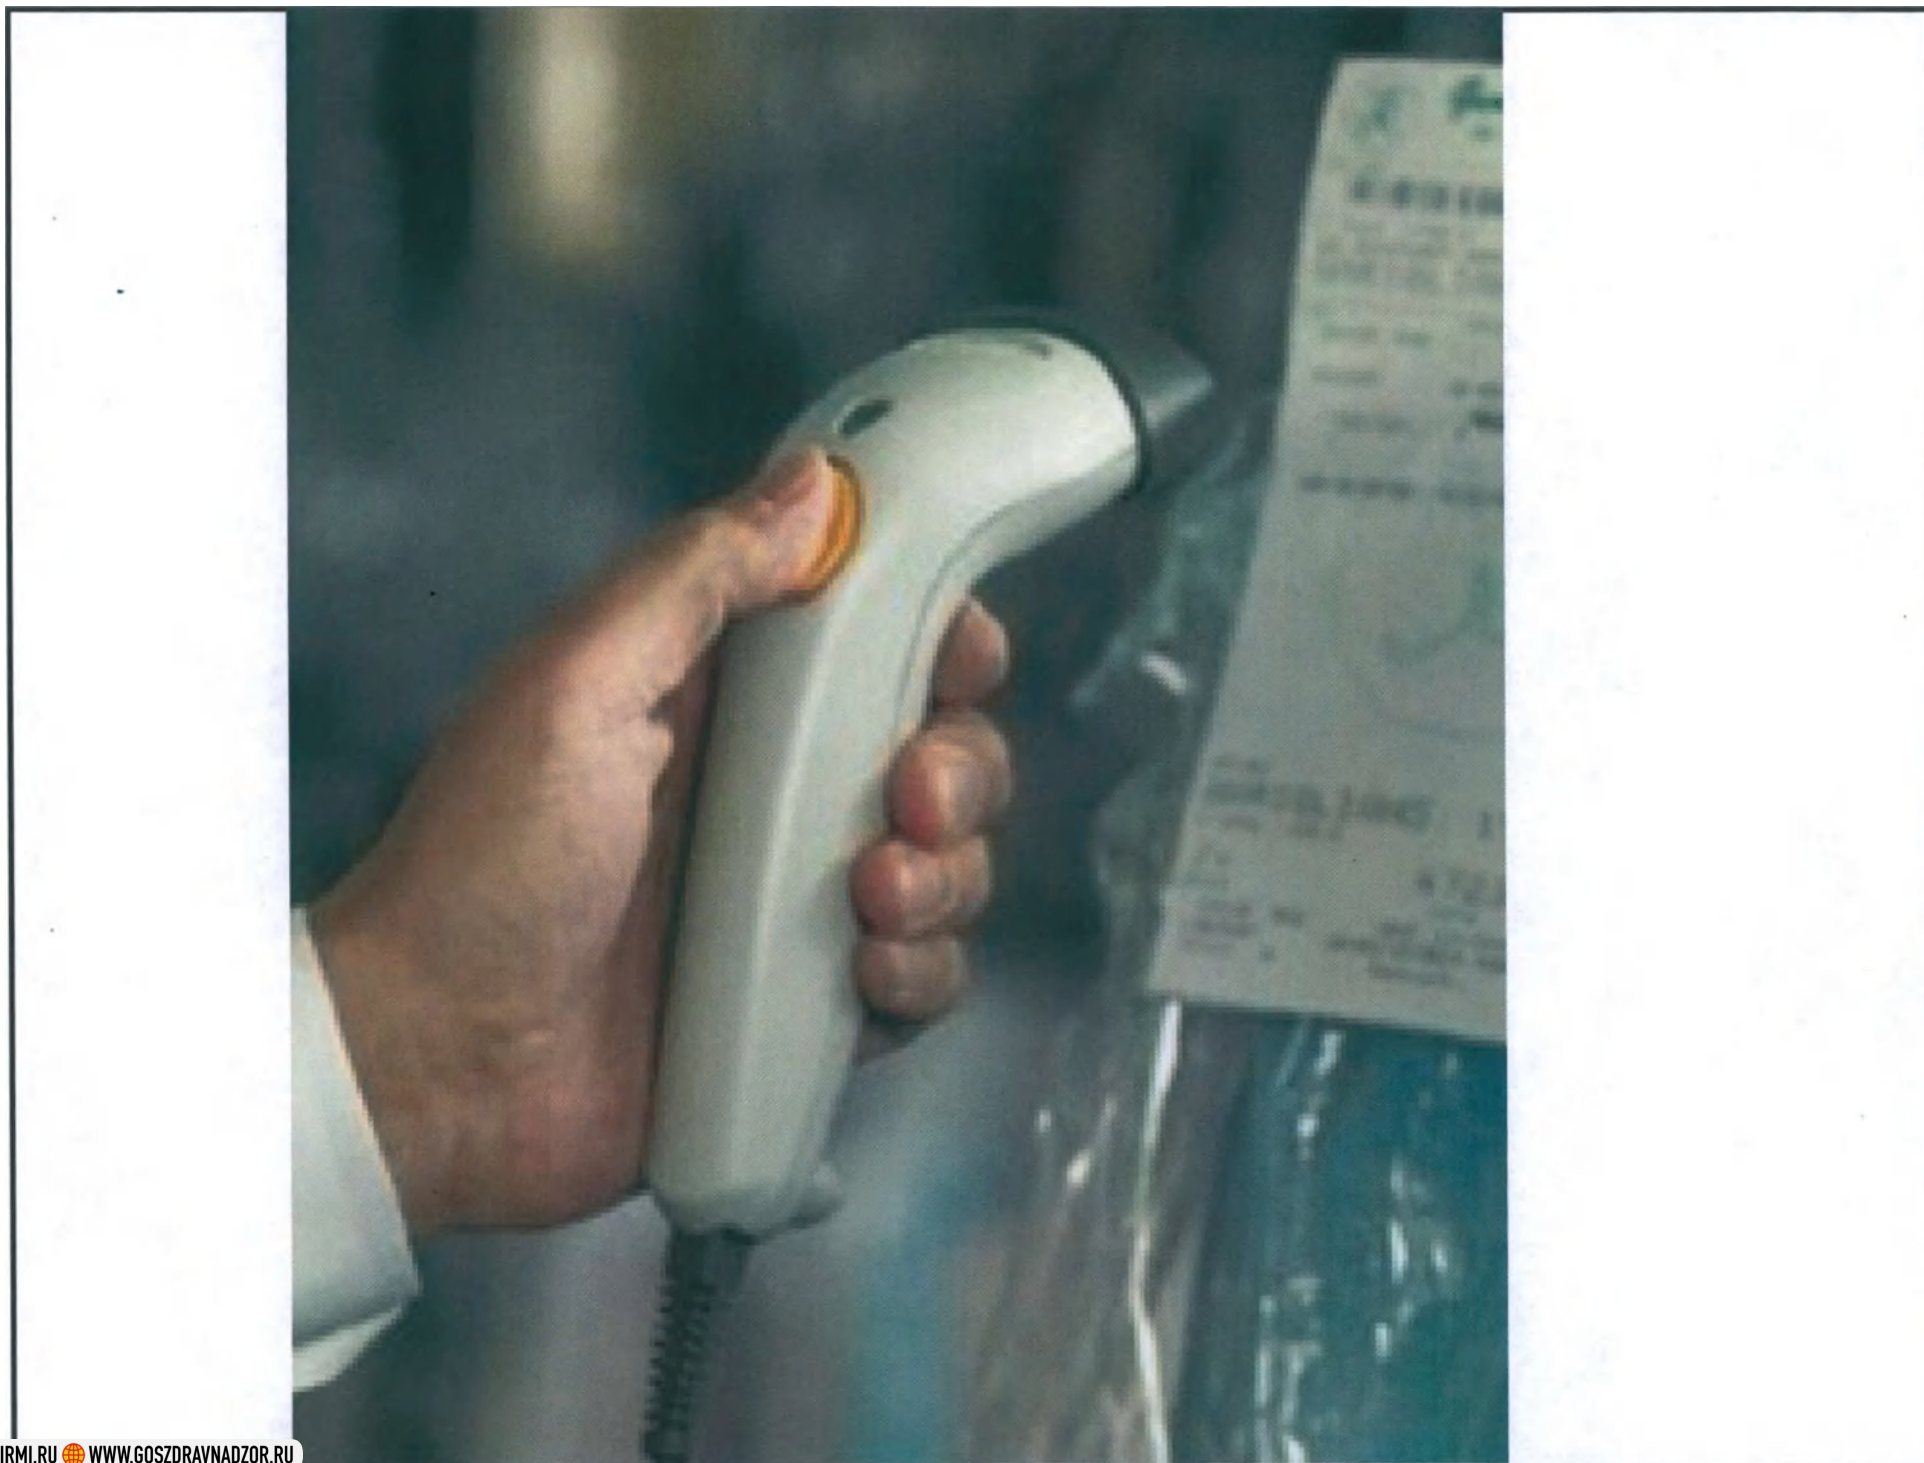













138. Демонстрационные изображения КТ (не более 20 шт.).

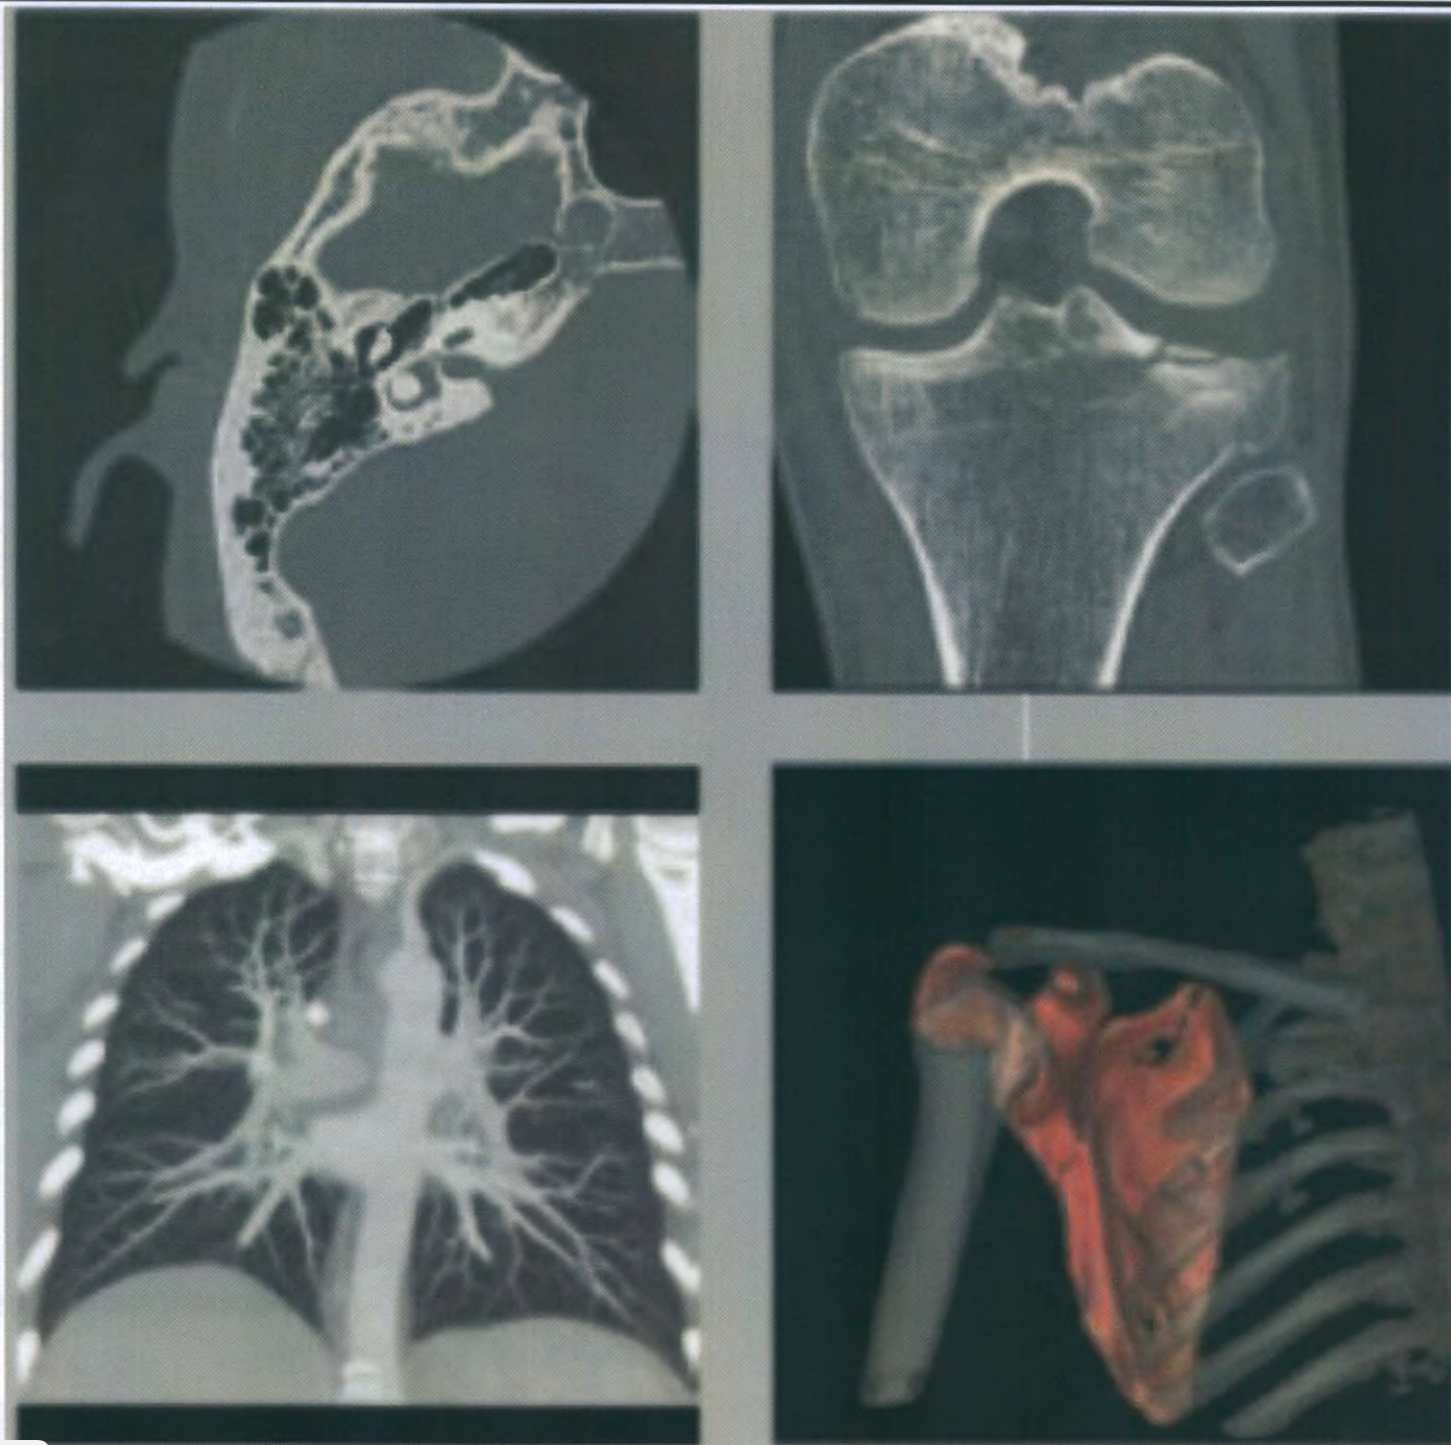


139. Устройства крепления блоков кардиологического мониторинга и синхронизации (не более 5 шт.)





139. Устройства крепления блоков кардиологического мониторинга и синхронизации (не более 5 шт.)

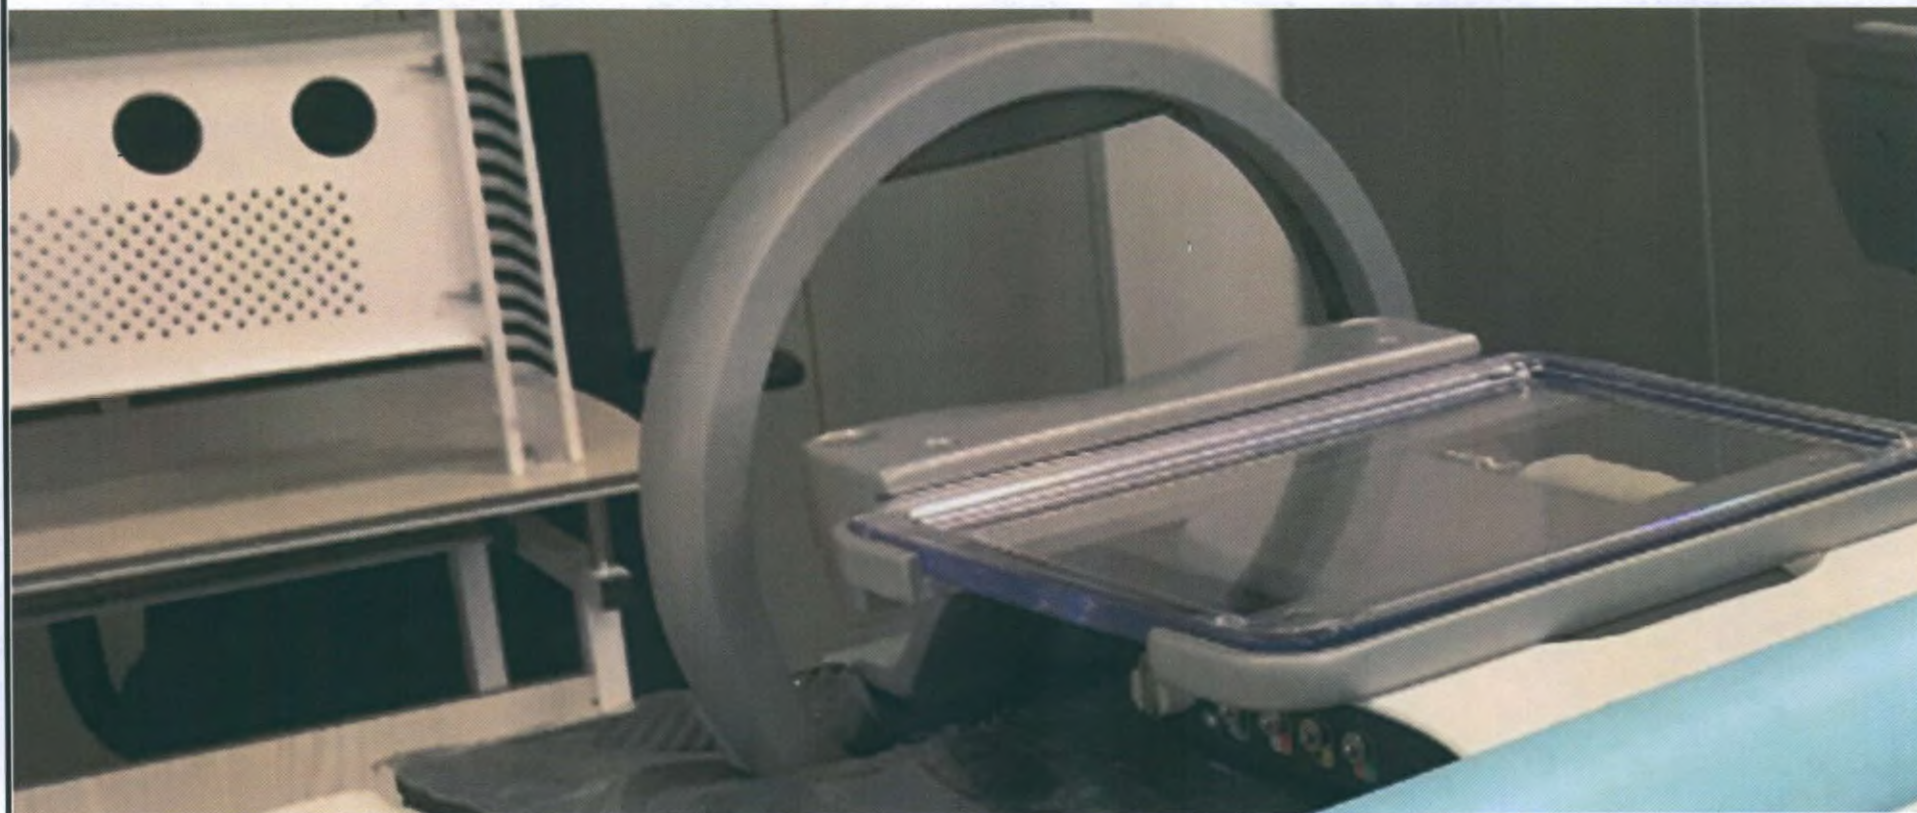

140. Держатель для инфузионных стоек (не более 5 шт.)

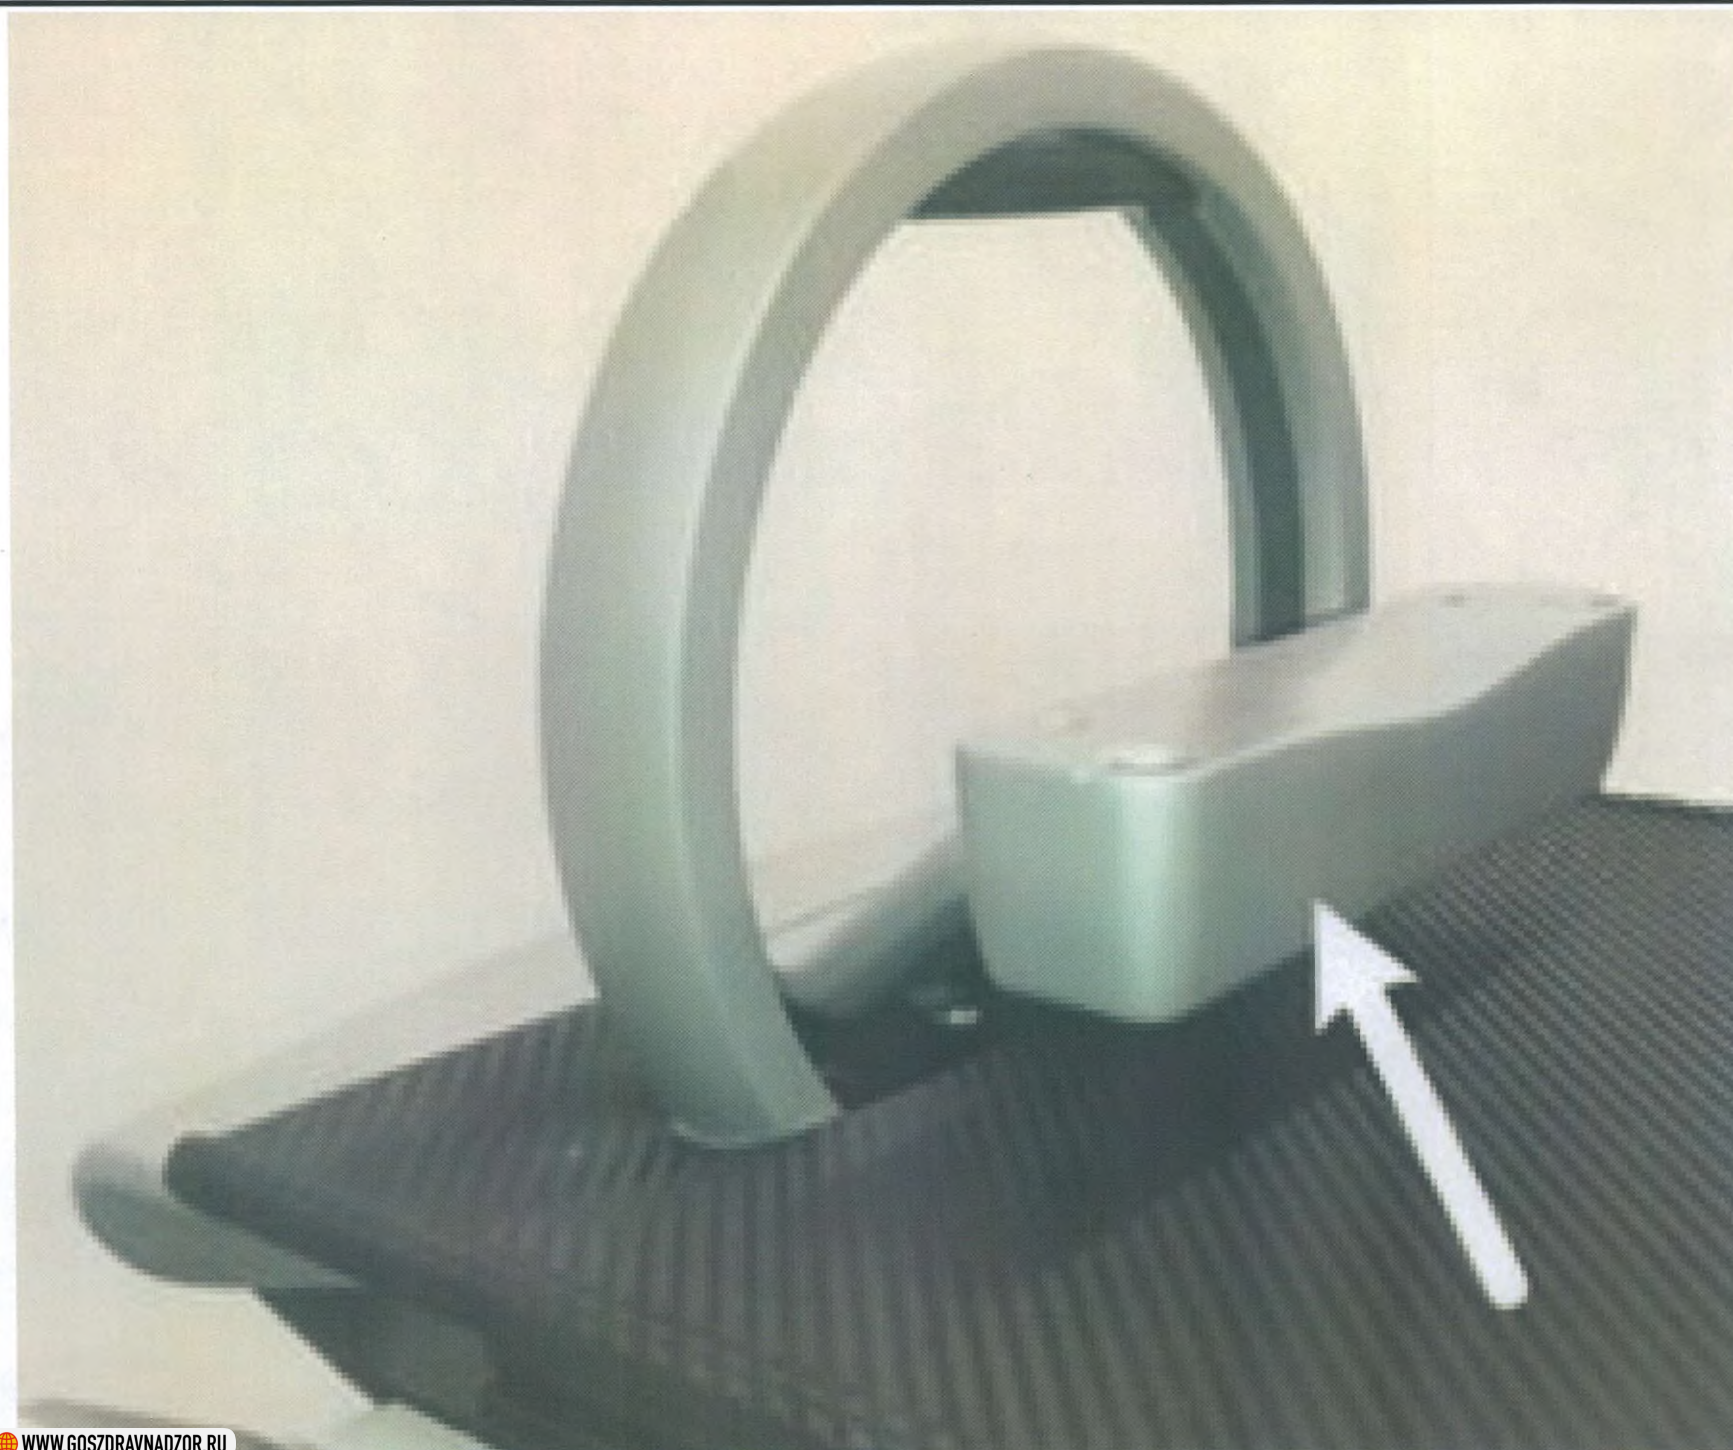

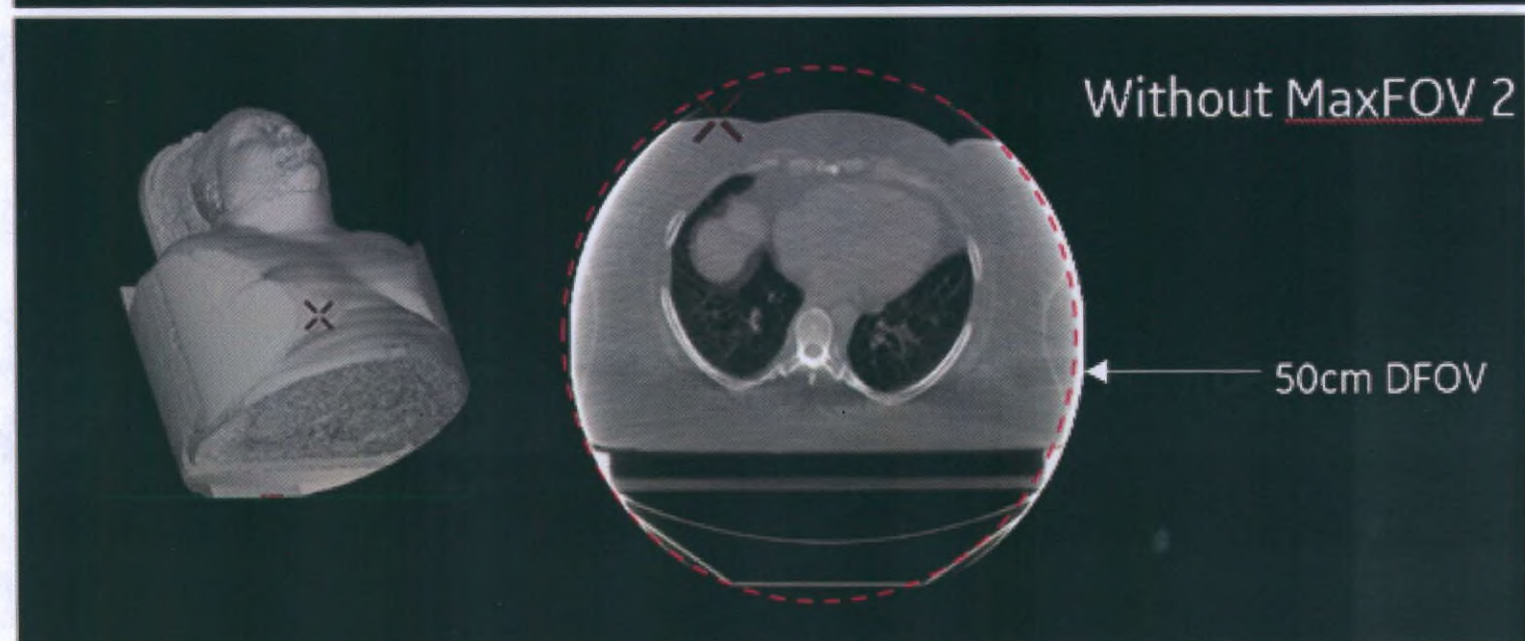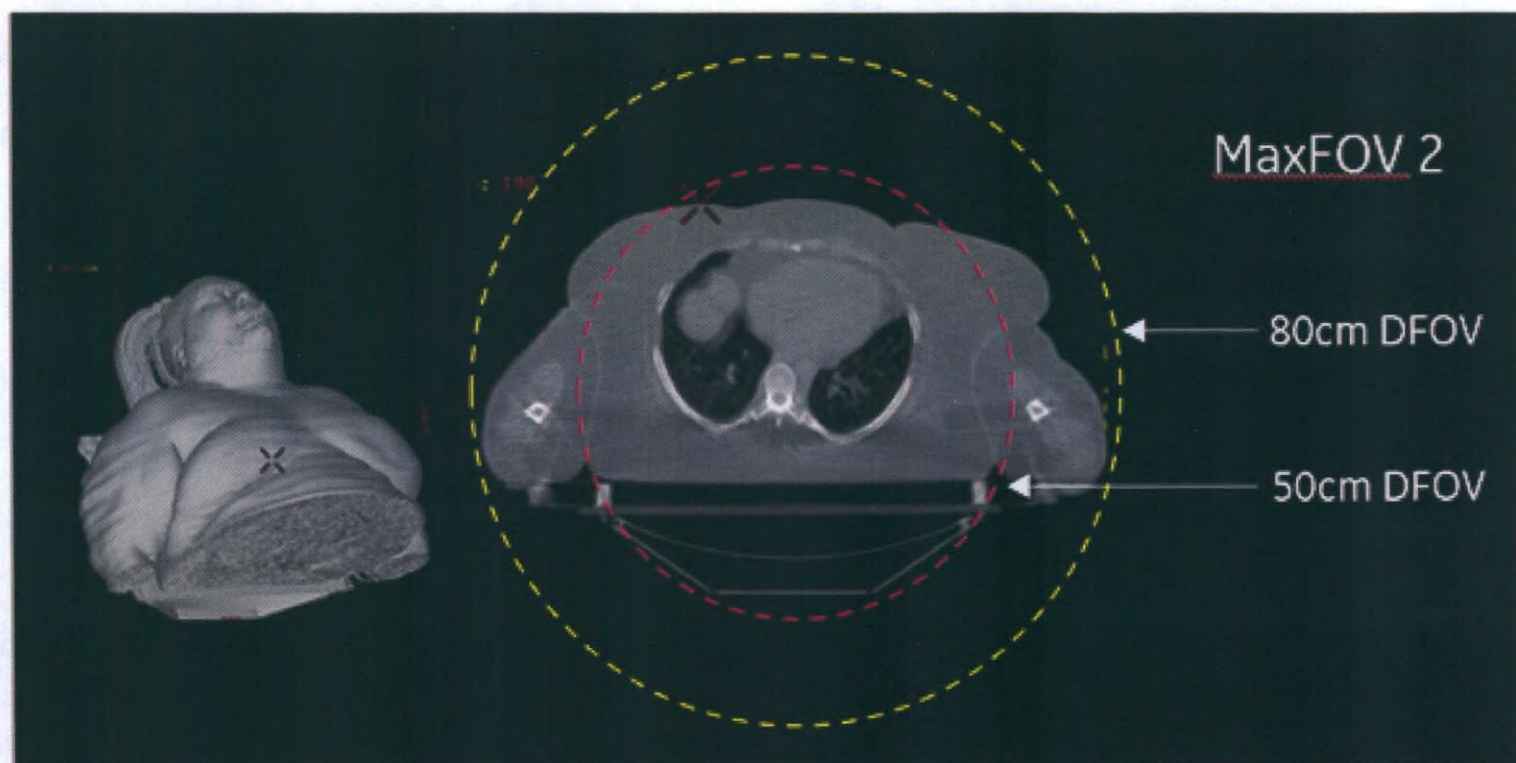

142. Программно-аппаратный пакет сетевого управления ИБП (не более 5 шт.).



143. Внешний жесткий диск (не более 5 шт.).




143. Внешний жесткий диск (не более 5 шт.).



143. Внешний жесткий диск (не более 5 шт.).



144. Приспособления для фиксации и позиционирования младенцев и детей (не более 5 шт.).

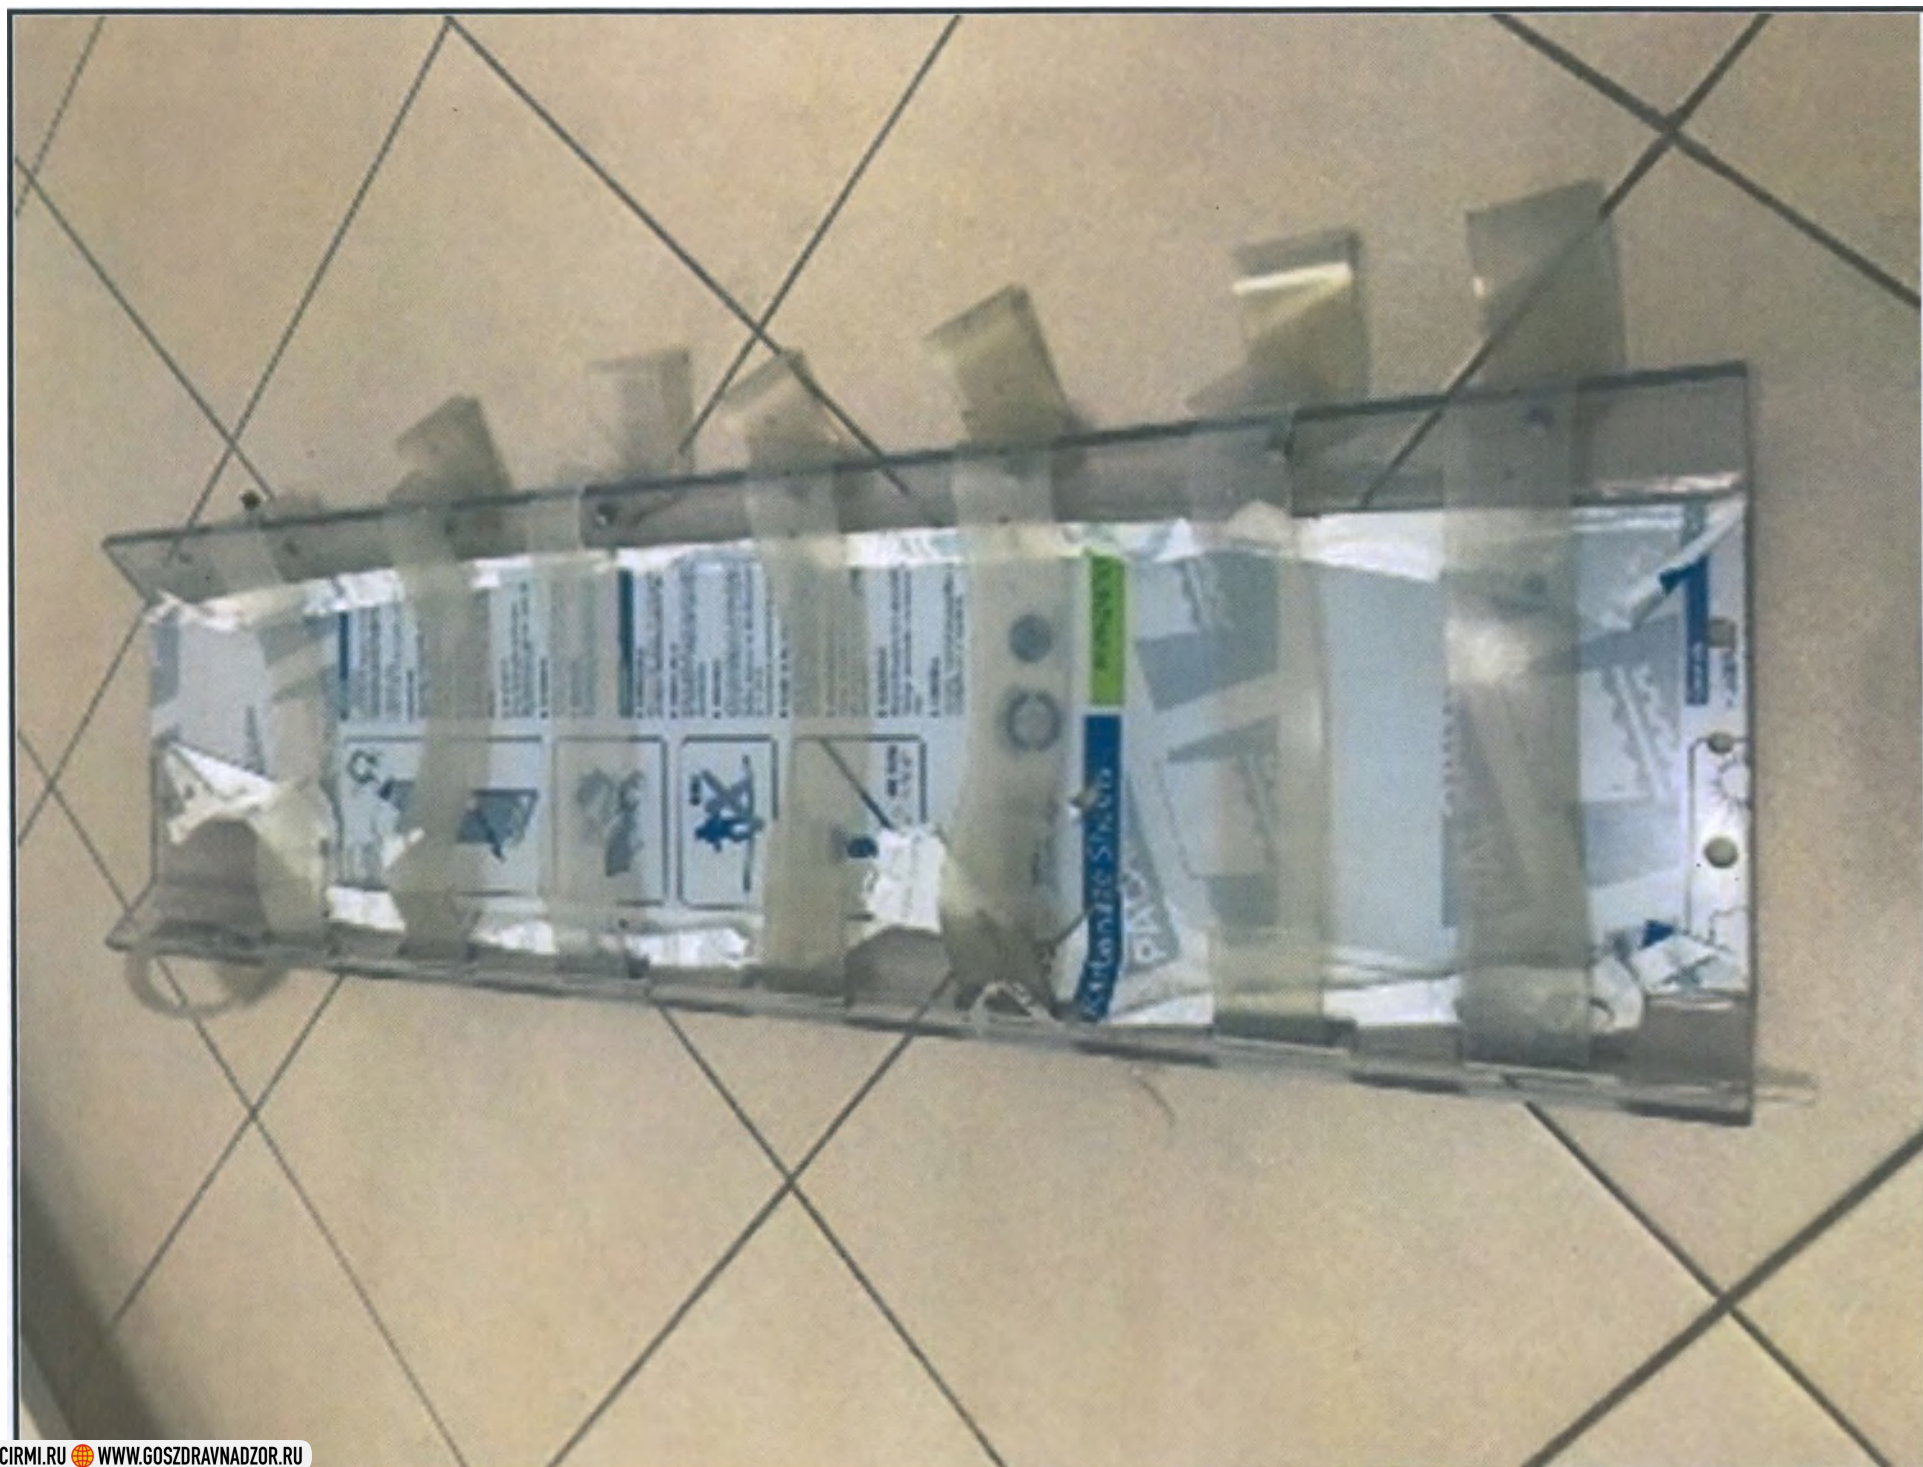

145. DVD привод для записи результатов исследования (не более 5 шт.).



146. Держатель рулонов одноразового покрытия для стола пациента (не более 5 шт.).




147. Кабели для устройства синхронизации сканирования с дыханием пациента (не более 20 шт.)



148. Приспособления для проведения интервенционных процедур под контролем КТ.



148. Приспособления для проведения интервенционных процедур под контролем КТ.

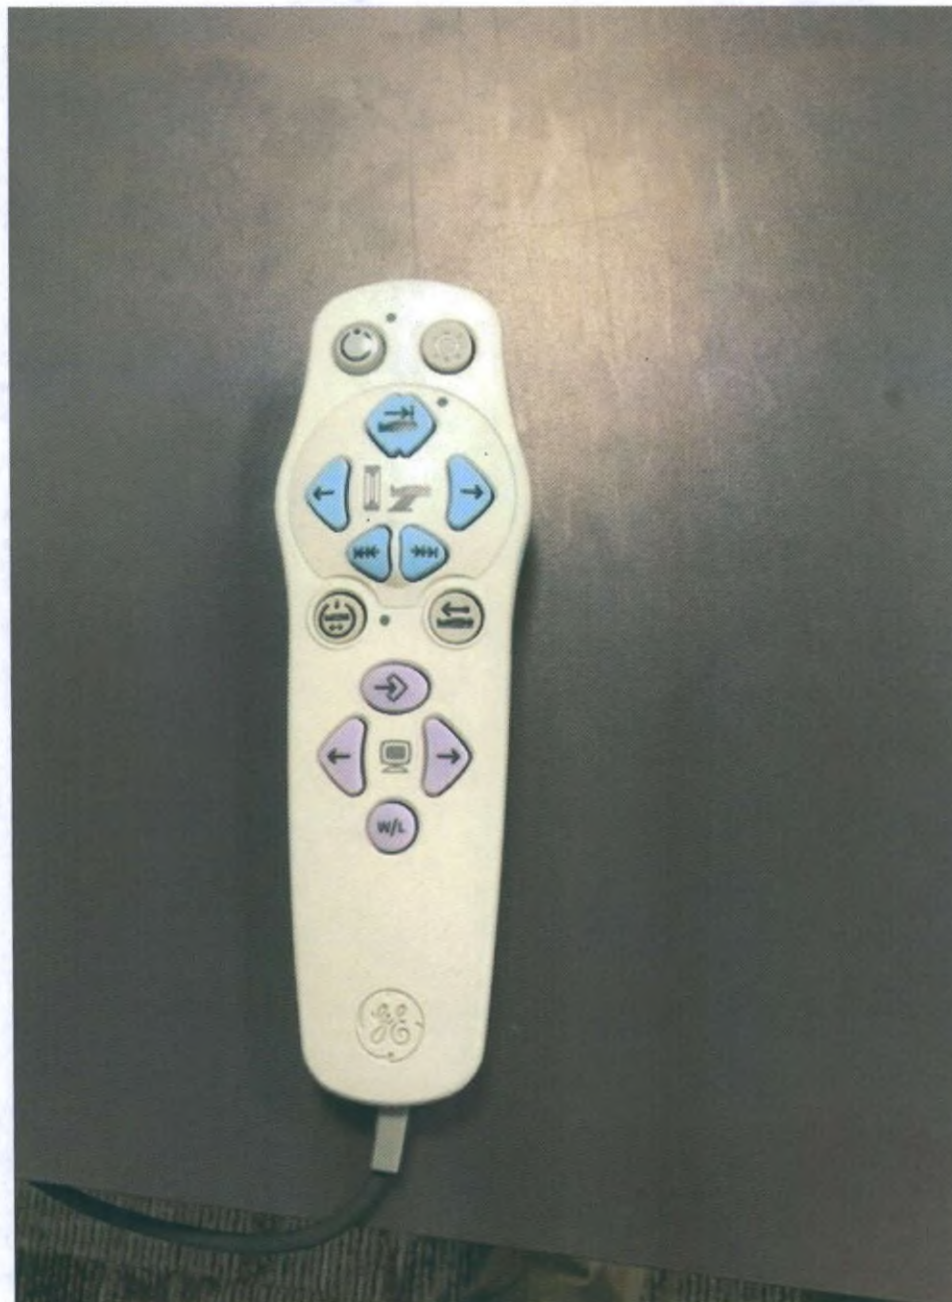

148. Приспособления для проведения интервенционных процедур под контролем КТ.



149. Рабочие станции серверного типа для работы с функциональными изображениями (не более 5 шт.).



149. Рабочие станции серверного типа для работы с функциональными изображениями (не более 5 шт.).



149. Рабочие станции серверного типа для работы с функциональными изображениями (не более 5 шт.).



149. Рабочие станции серверного типа для работы с функциональными изображениями (не более 5 шт.).




150. Приспособления для установки рабочей станции серверного типа (не более 5 шт.).



150. Приспособления для установки рабочей станции серверного типа (не более 5 шт.).



151. Мониторы для рабочей станции (не более 6 шт.).

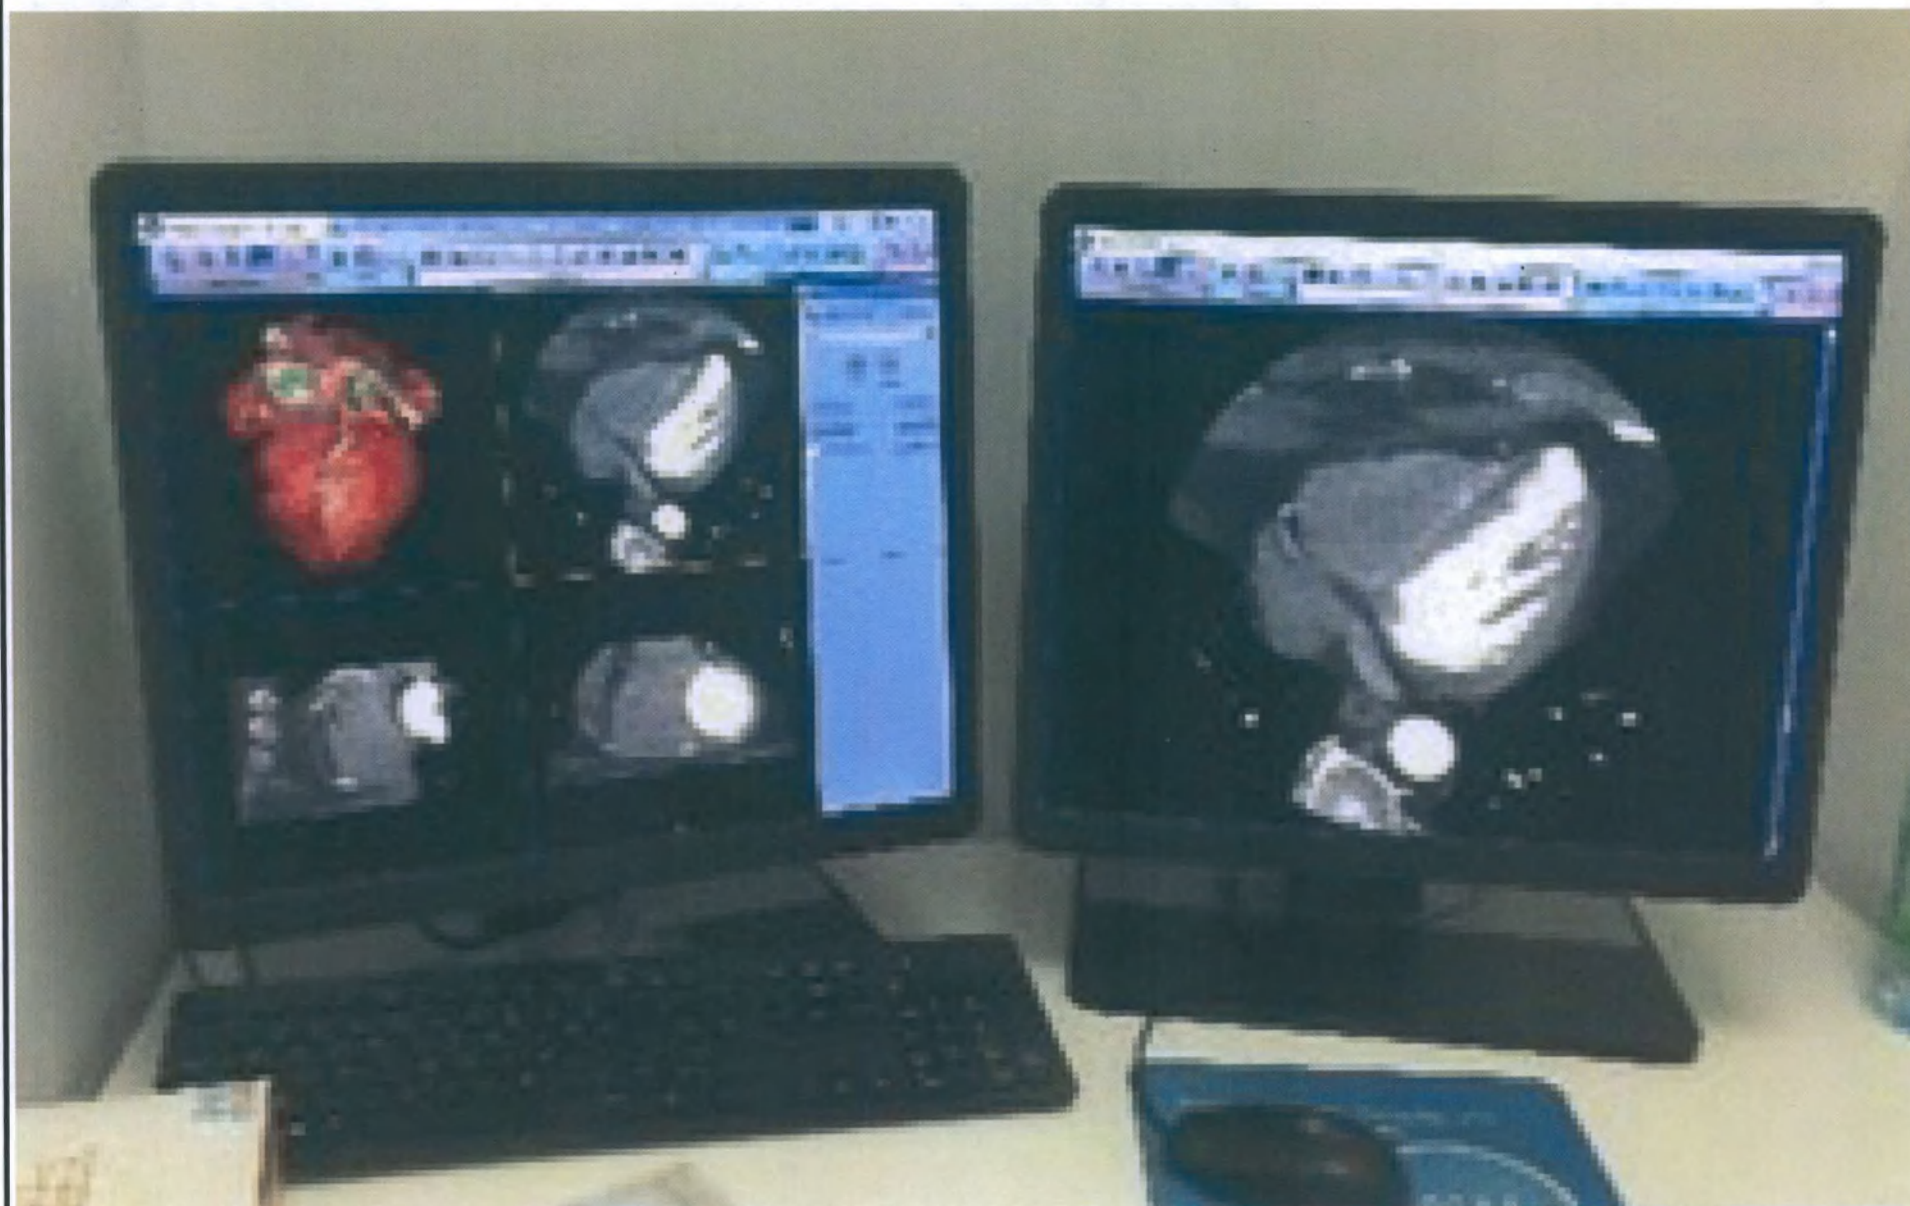

152. Лазерные устройства для позиционирования, разметки, маркировки пациента (не более 5 шт.).



153. Устройство для наблюдения за пациентом и дистанционного управления аппаратом (не более 10 шт.).



153. Устройство для наблюдения за пациентом и дистанционного управления аппаратом (не более 10 шт.).



153. Устройство для наблюдения за пациентом и дистанционного управления аппаратом (не более 10 шт.).




153. Устройство для наблюдения за пациентом и дистанционного управления аппаратом (не более 10 шт.).







155. Программное обеспечение для связи с сервером обработки диагностических данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях-(не более 10 шт.).

220

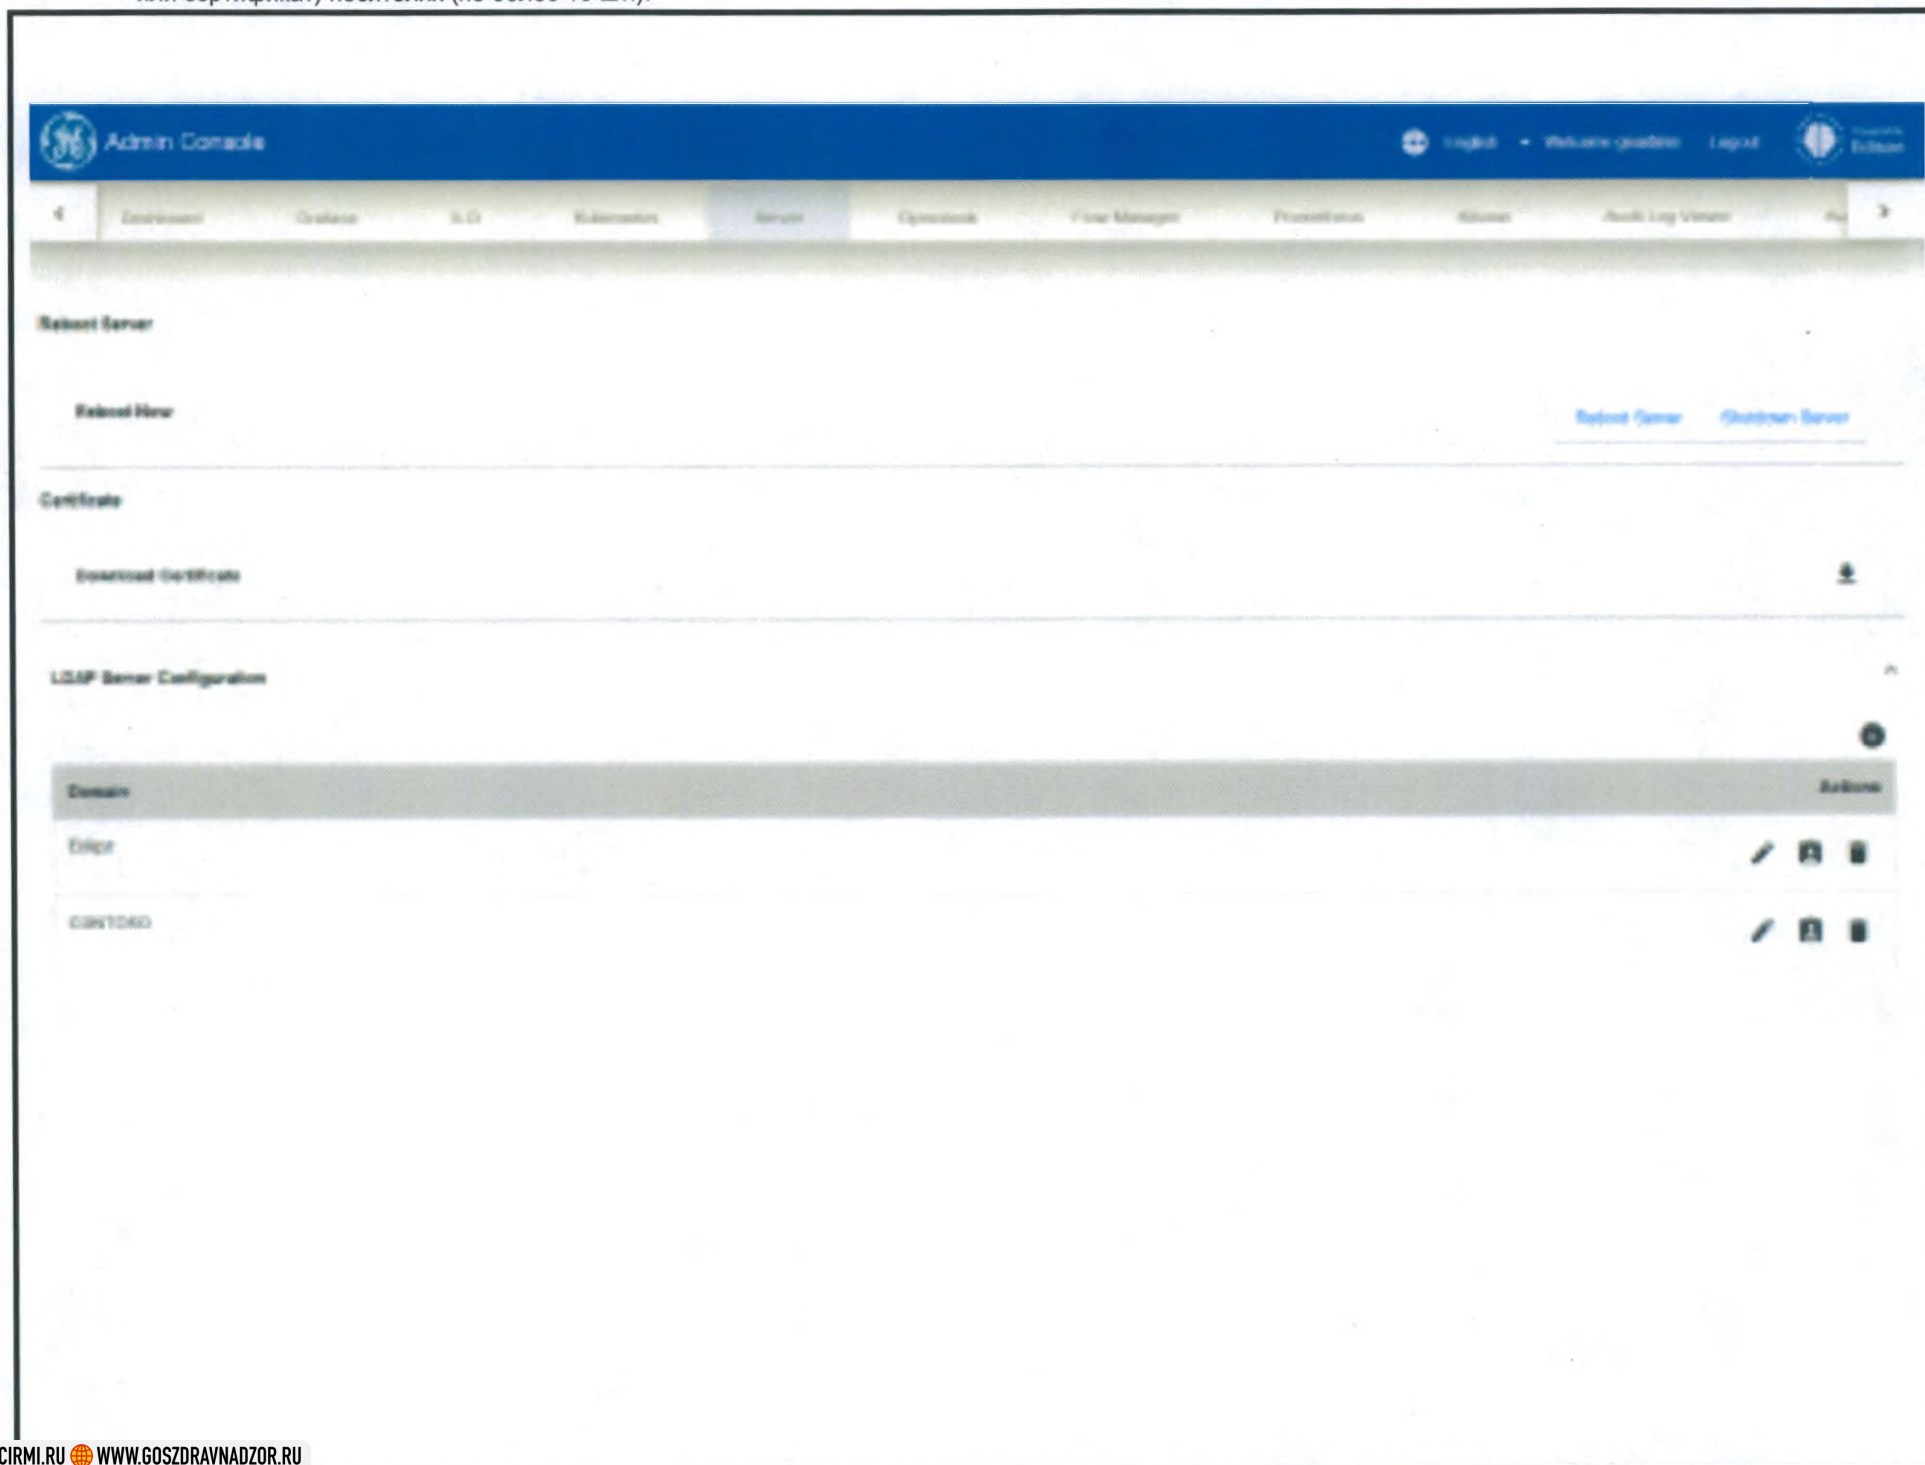

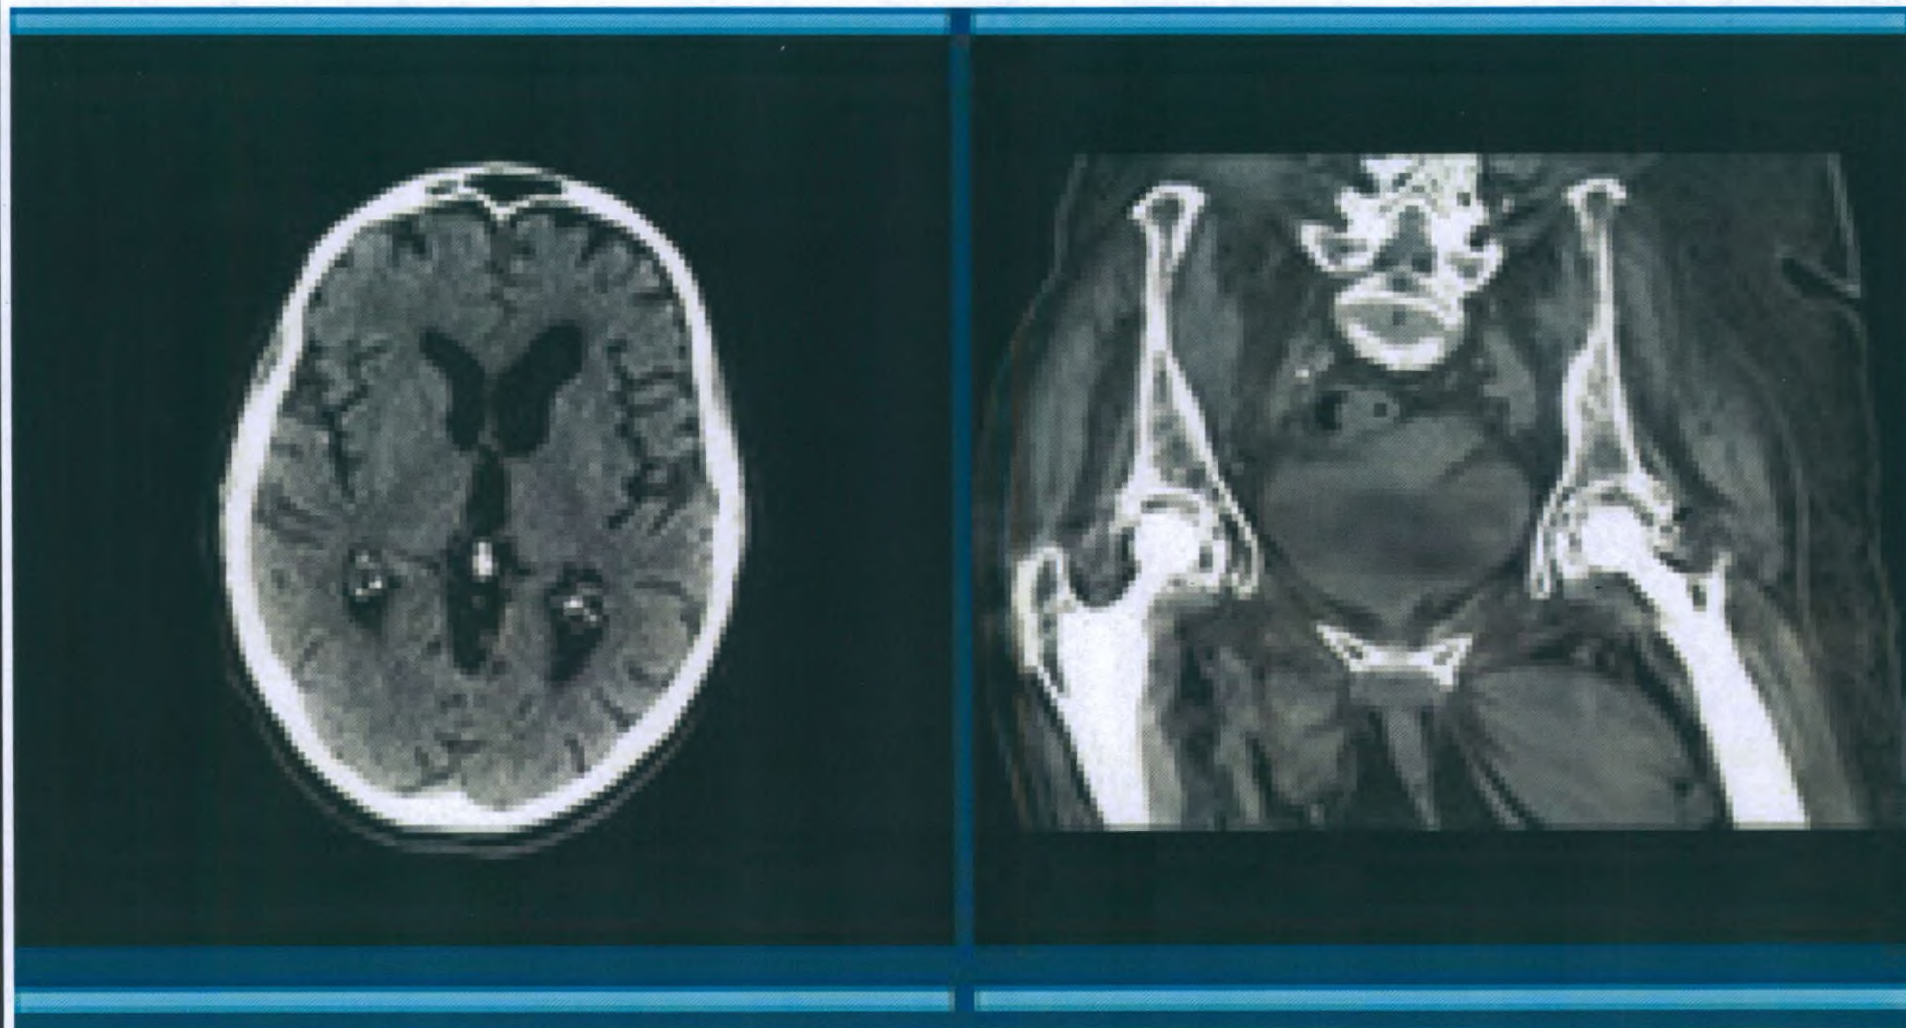

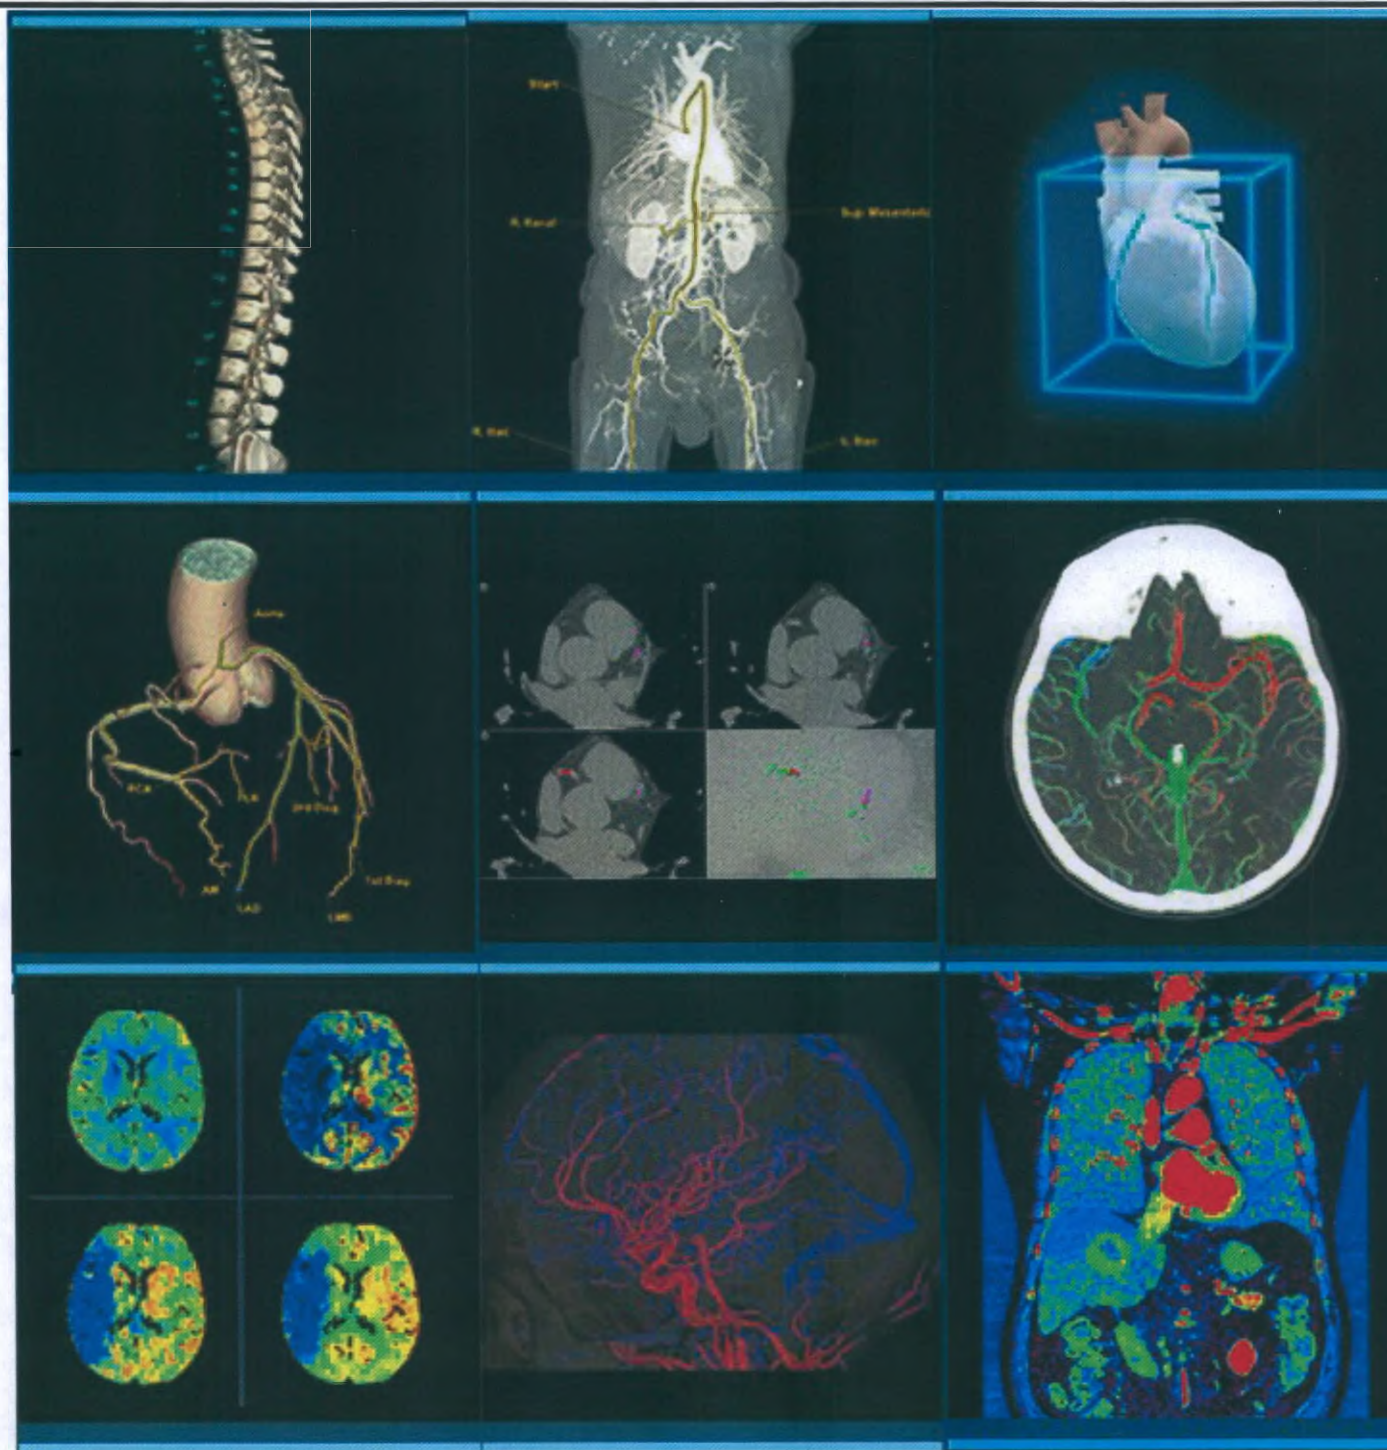



159. Программный пакет для реконструкции с применением технологий глубинного обучения для спектральной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).

Recon Settings

Thickness 5.0 mm

Recon Type Stnd#

Enhanced Contrast EC1

Fine Z (#Z) Off

Recon Mode Plus Off

Image Enhance Filter None

ASiR-V 50%

DLIR High

Window Width

Window Level

Flip / Rotate



Off

Low

Medium

High



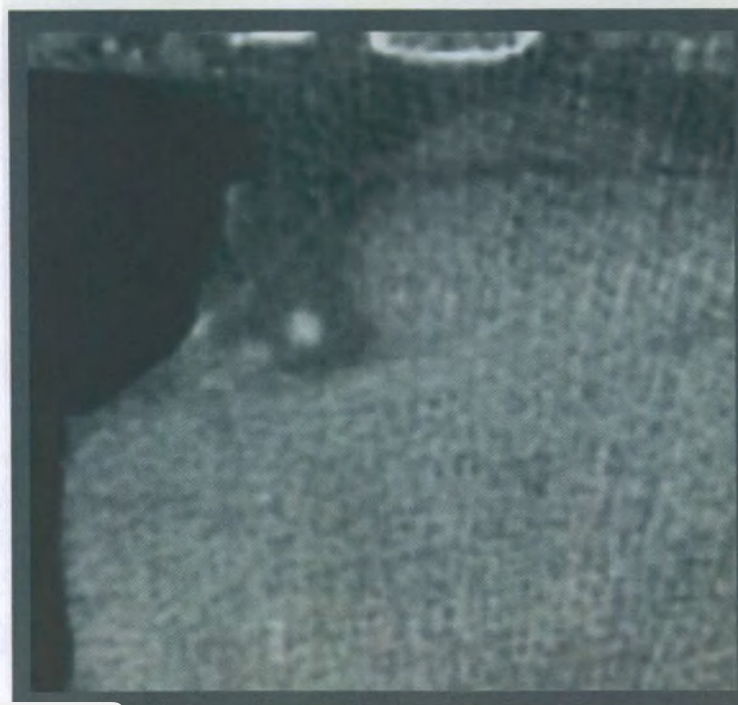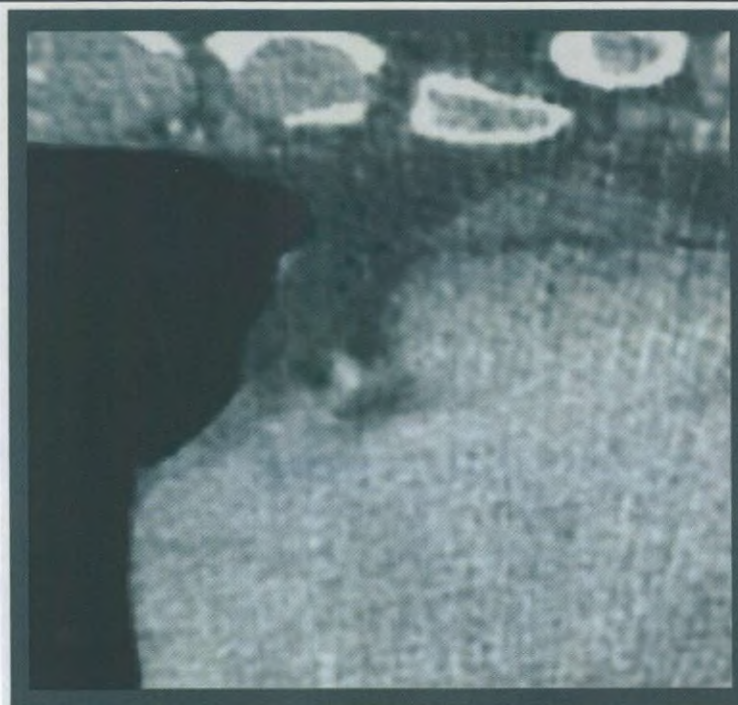

163. Набор для сейсмоопасных зон (не более 5 шт.).



164. Набор для плоской накладки на стол (не более 5 шт.).



165. Кожухи для кабелей защитные (не более 20 шт.).





168. Программный пакет для анализа костного мозга на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях (не более 10 шт.).



ПРОШТО И СКРЕТЈЕНО
ПЧАТБЮ 23 ЛИСТА(ОВ)

Дугер по
рецидиву
Артеријале 20.28.

