

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Реагенты в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-Tg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), в вариантах исполнения

производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany

Elecsys Anti-Tg

cobas e analyzers

REF 10004596190

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY
Made in Germany

4871
PVT 1000
P3324213/280-1P364
P301

CONTENT

100

M 12 mL
R1 10 mL
R2 10 mL

! (Warning symbol)

QR code

IVD CE (11/20) λ -8 °C


Roche logo

cobas

Анты в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-Tg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 100 тестов



теты в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях
мунохимических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 100 тестов

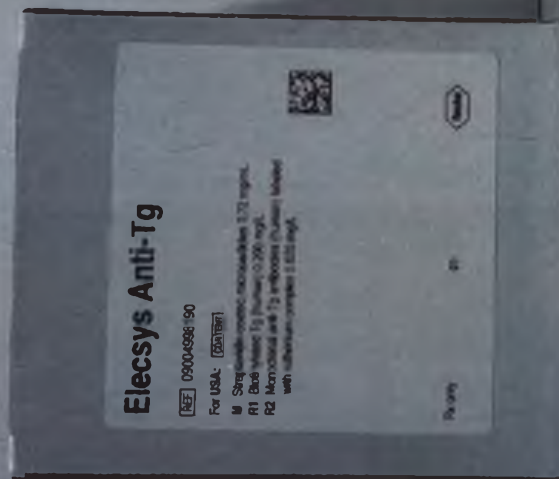


кассеты в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-Tg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 100 тестов



Elecsys®

ты в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
имунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях
мунохимических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 100 тестов

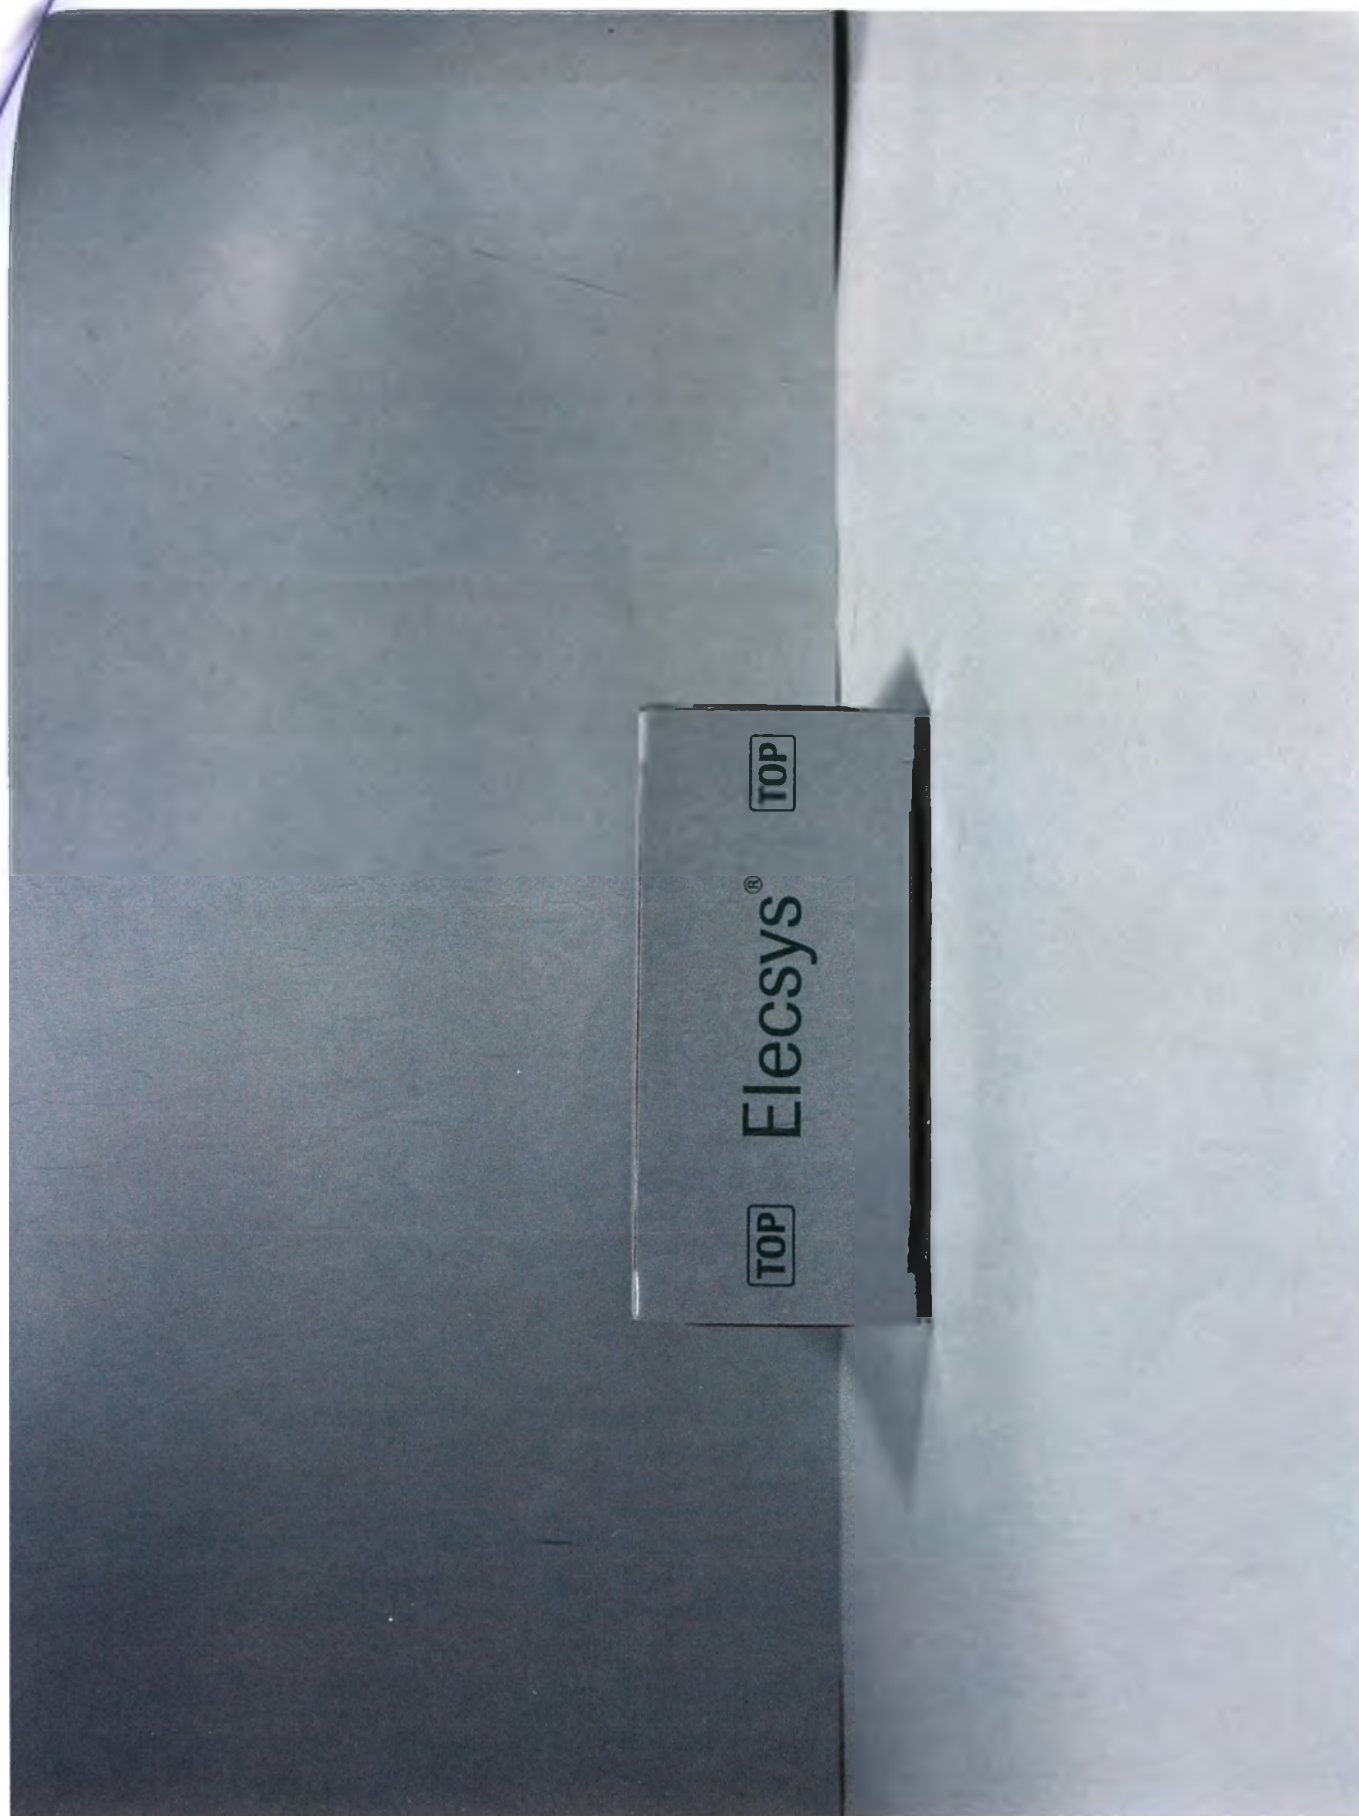

Elecsys Anti-Tg

cobas e analyzers

REF 0900498190

COBAS, COBAS E and ELECSYS are trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics
Indianapolis, IN
Made in Germany

01

MD CE 0123

2-8 °C

100

CONTENT

M	12 mL
RT	10 mL
RZ	10 mL

100

! i

0900498190

Elecsys

ATG

2201

LOT 56162401


2022-10-31

2-8 °C

MD

Roche

титры в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
 мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях
 мунохимических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 100 тестов

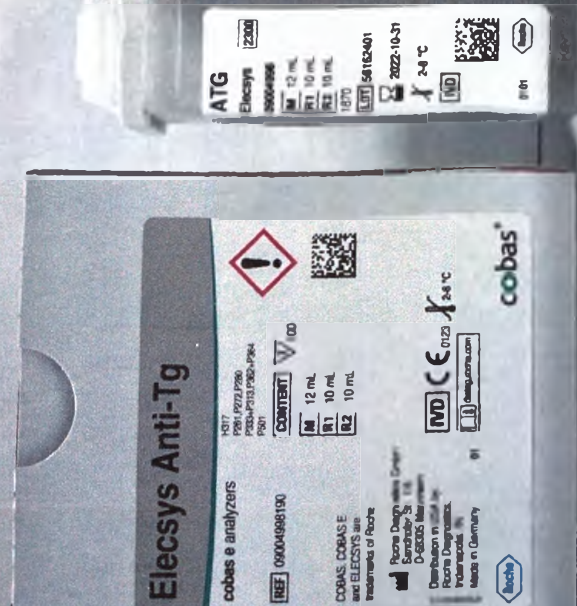


титры в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов



кассеты в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях
химических cobas c (Elecsys Anti-Tg cobas c analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов



ы в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях
аналитических cobas e (Elecsys Anti-Ig cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов

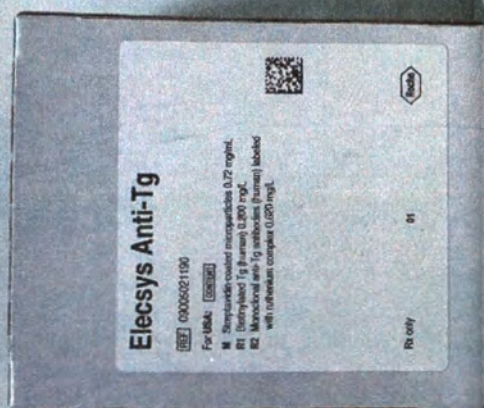

ы в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях
нохимических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов



в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
имунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях
химических cobas e (Elecsys Anti-Ig cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов



в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях
 химических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов



в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях
химических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов



в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях химических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов



в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-
мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях
химических cobas e (Elecsys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов



в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-иммунохемиллюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях химических cobas e (Elecys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов

 Реагенты в кассете для количественного определения содержания антител к тиреоглобулину (Anti-Tg) иммунохемиллюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecys Anti-Tg cobas e analyzers/ATG), вариант исполнения 300 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11503 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik GmbH", Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия)

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рос Диалогтика Рус» (ООО «Рос Диалогтика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: moscow.registration2.dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 09005021190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
18 листа (ов)



по доверенности
от 11.02.2022 г.