

Генеральный директор
ООО «РЭМО-ТЕХНОЛОГИИ»

«21» ноября 2022 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Данные о маркировке и упаковке указаны в п.1.5 и п.1.6 ТУ 32.50.50-004-13760586-2020
2. Макеты этикеток на рисунках, представленных ниже:

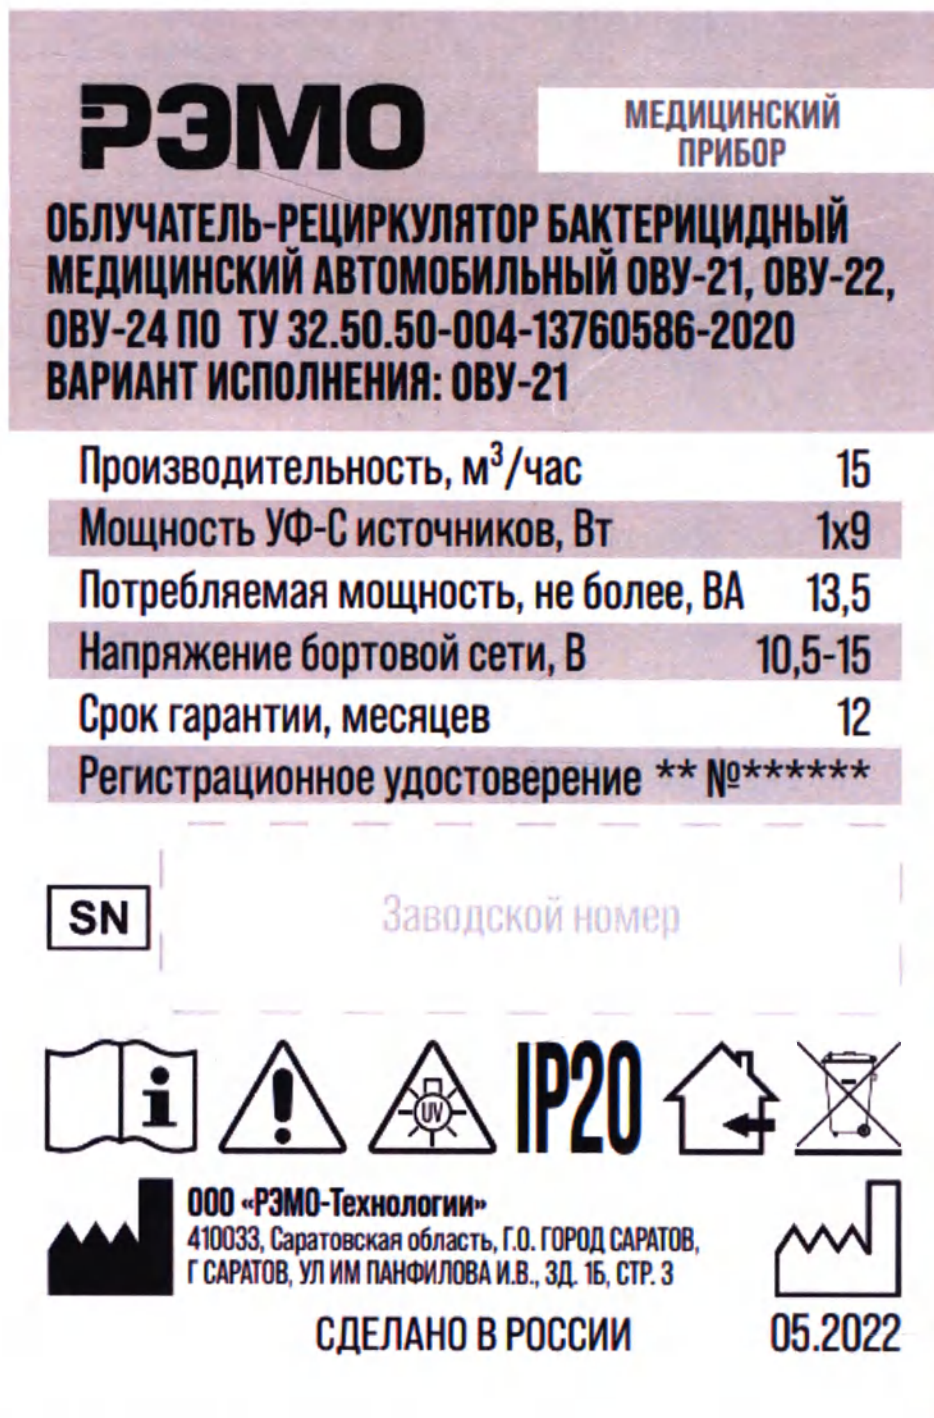


Рисунок 1.1 – Макет этикетки Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР
БАКТЕРИЦИДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОВУ-21,
ОВУ-22, ОВУ-24 ПО ТУ 32.50.50-004-13760588-2020



ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:
ОВУ-21

1 × 9Вт



Очистка воздуха
от вирусов
и бактерий



Ультрафиолетовая
обработка



Безопасная работа
в присутствии людей
и животных



Номинальное
напряжение
бортовой сети

12В



Наименование и адрес местонахождения изготовителя:
410033, Саратовская область, г.О. ГОРОД САРАТОВ,
г САРАТОВ, УЛ ИМ ПАНОФИЛОВА Н.В., ЗД. 15, СТР. 3



06.2822

Замечания по работе изделия, повреждению или предположению следует
направлять по адресу: 410052, Россия, Саратов, а/п 500.
Тел.: 8 (800) 775-07-94. E-mail: help@remo-zavod.ru, www.remo-zavod.ru

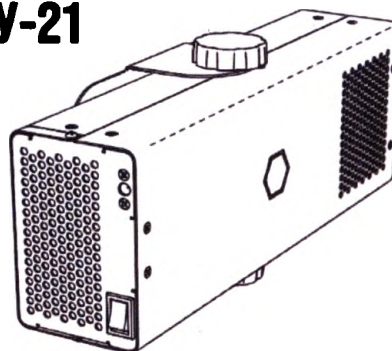


Рисунок 1.2 – Макет этикетки транспортной упаковки Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21 по ТУ 32.50.50-004-13760588-2020

РЭМО

МЕДИЦИНСКИЙ
ПРИБОР

**ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОВУ-21, ОВУ-22,
ОВУ-24 ПО ТУ 32.50.50-004-13760586-2020
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ОВУ-22**

Производительность, м³/час 75

Мощность УФ-С источников, Вт 2x9

Потребляемая мощность, не более, ВА 36

Напряжение бортовой сети, В 10,5-15

Срок гарантии, месяцев 12

Регистрационное удостоверение ** №*****

SN

Заводской номер



IP20



ООО «РЭМО-Технологии»
410033, Саратовская область, Г.О. ГОРОД САРАТОВ,
Г САРАТОВ, УЛ ИМ ПАНФИЛОВА И.В., ЗД. 1Б, СТР. 3



СДЕЛАНО В РОССИИ

05.2022

Рисунок 2.1 – Макет этикетки Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

РЭМО

Сделано
в России

МЕДИЦИНСКОЕ
ИЗДЕЛИЕ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
** № *****

SN

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР
БАКТЕРИЦИДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОВУ-21,
ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020



ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:
ОВУ-22

2 × 9Вт



Очистка воздуха
от вирусов
и бактерий



Ультрафиолетовая
обработка



Безопасная работа
в присутствии людей
и животных



Номинальное
напряжение
бортовой сети

12В



Наименование и адрес местонахождения изготовителя:
410033, Саратовская область, Г.О. ГОРОД САРАТОВ,
Г САРАТОВ, УЛ ИМ ПАНИФИЛОВА И.В., ЗД. 16, СТР. 3



05.2022

Замечания по работе изделия, пожелания или предложения следует
направлять по адресу: 410052, Россия, Саратов, в/я 500.
Тел.: 8 (800) 775-07-94, E-mail: help@remo-zavod.ru, www.remo-zavod.ru

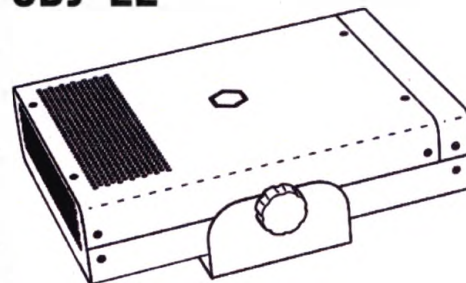


Рисунок 2.2 – Макет этикетки транспортной упаковки Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020



РЭМО

МЕДИЦИНСКИЙ
ПРИБОР

**ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОВУ-21, ОВУ-22,
ОВУ-24 ПО ТУ 32.50.50-004-13760586-2020
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: ОВУ-24**

Производительность, м³/час 75

Мощность УФ-С источников, Вт 2x15

Потребляемая мощность, не более, ВА 60

Напряжение бортовой сети, В 10,5-15

Срок гарантии, месяцев 12

Регистрационное удостоверение ** №*****

SN

Заводской номер



IP55



ООО «РЭМО-Технологии»
410033, Саратовская область, Г.О. ГОРОД САРАТОВ,
Г САРАТОВ, УЛ ИМ ПАНФИЛОВА И.В., ЗД. 1Б, СТР. 3



СДЕЛАНО В РОССИИ

05.2022

Рисунок 3.1 – Макет этикетки Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

РЭМО

Сделано
в России

МЕДИЦИНСКОЕ
ИЗДЕЛИЕ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ *****

SN

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР
БАКТЕРИЦИДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОВУ-21,
ОВУ-22, ОВУ-24 ПО ТУ 32.50.50-004-13760586-2020



ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:
ОВУ-24

2 × 15Вт



Очистка воздуха
от вирусов
и бактерий



Ультрафиолетовая
обработка



Безопасная работа
в присутствии людей
и животных



Номинальное
напряжение
бортовой сети

12В



416032251016199




Наименование и адрес местонахождения изготовителя:
410033, Саратовская область, Г.О. ГОРОД САРАТОВ,
Г САРАТОВ, УЛ ИМ ПАНИЛОВА И.В., ЗД. 16, СТР. 3



05.2022

Замечания по работе изделия, пожелания или предложения следует
направлять по адресу: 410052, Россия, Саратов, а/я 500.
Тел.: 8 (800) 775-07-94. E-mail: help@remo-zavod.ru, www.remo-zavod.ru

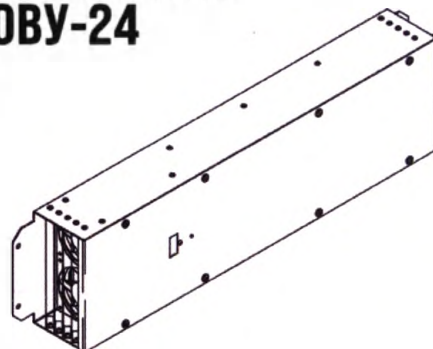

IP55



Рисунок 3.2 – Макет этикетки транспортной упаковки Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

Прошито и скреплено печатью
количество 7 (семь) листов

Генеральный директор
ООО «ВЭМО-ТЕХНОЛОГИИ»

/ А.И. Волошин /

Подпись

ФИО



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РЭМО-ТЕХНОЛОГИИ»

А. И. Волошин

«20» января 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия и принадлежностей (размер не менее 180 мм x 240 мм)

Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21,
ОВУ-22, ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

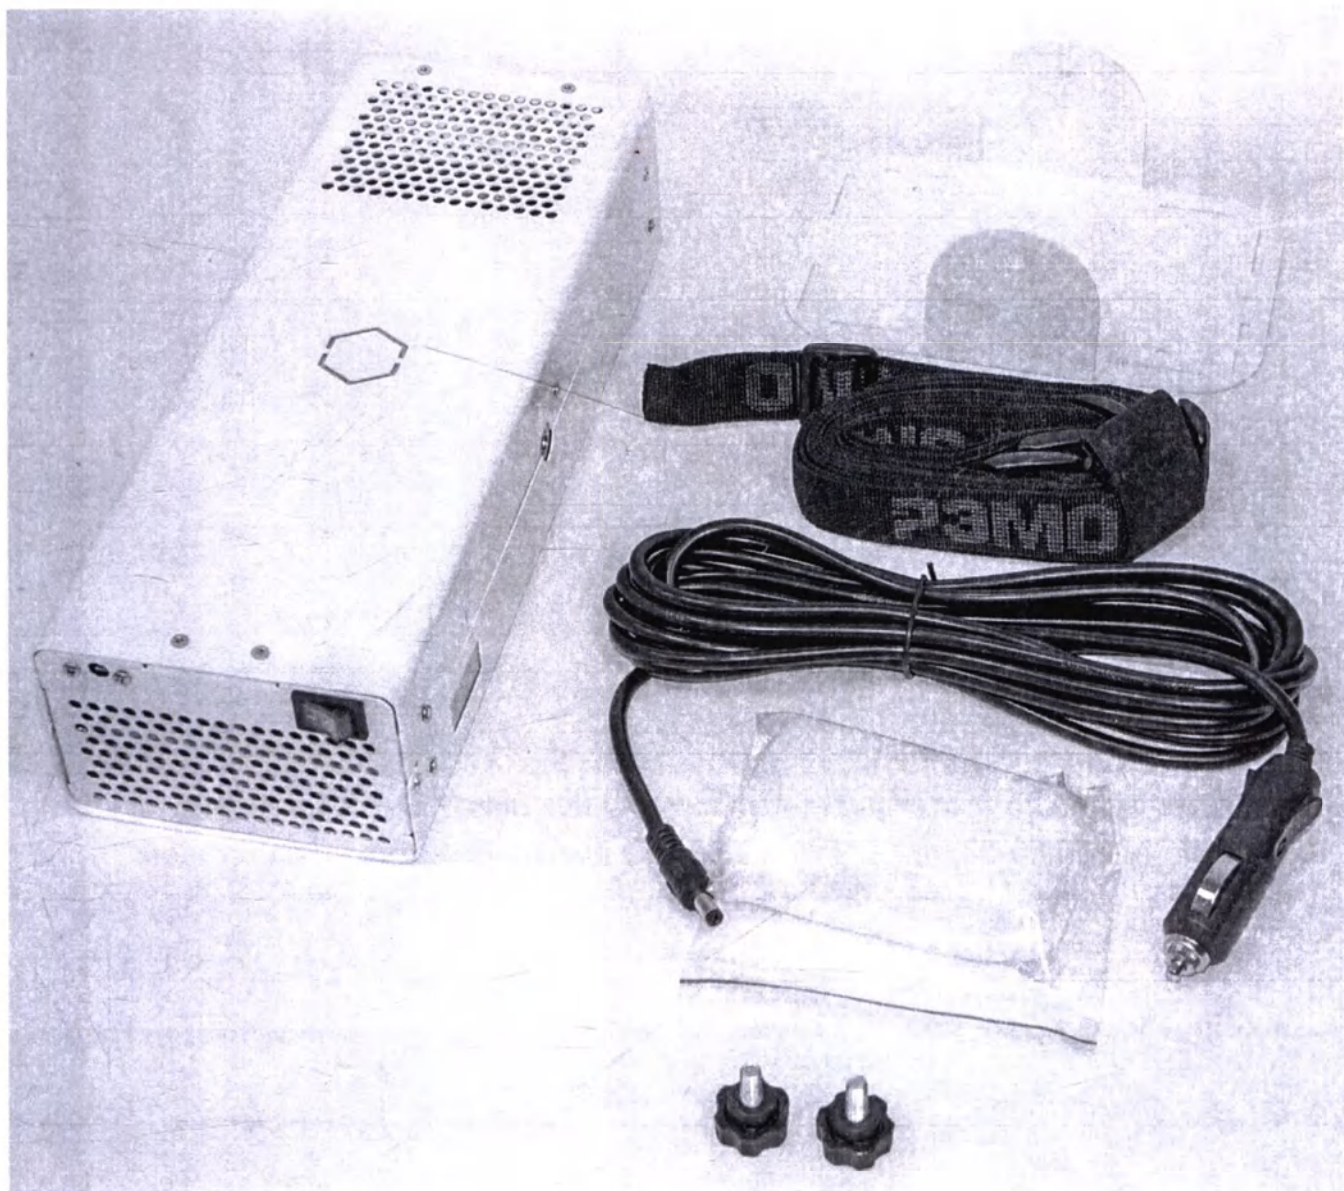


Рисунок 1.1 – Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский
автомобильный ОВУ-21 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020



Рисунок 1.2 – С этикеткой Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

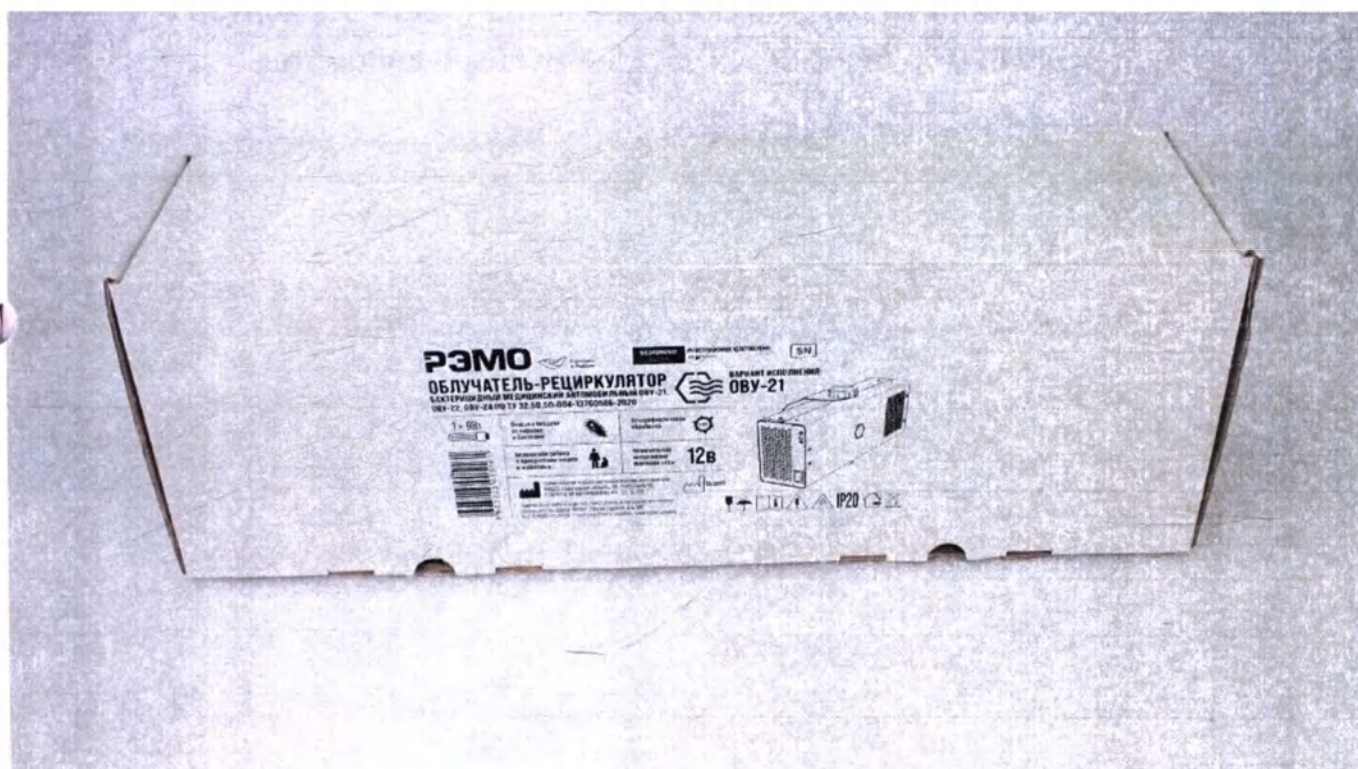


Рисунок 1.3 – В транспортной упаковке Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-21 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

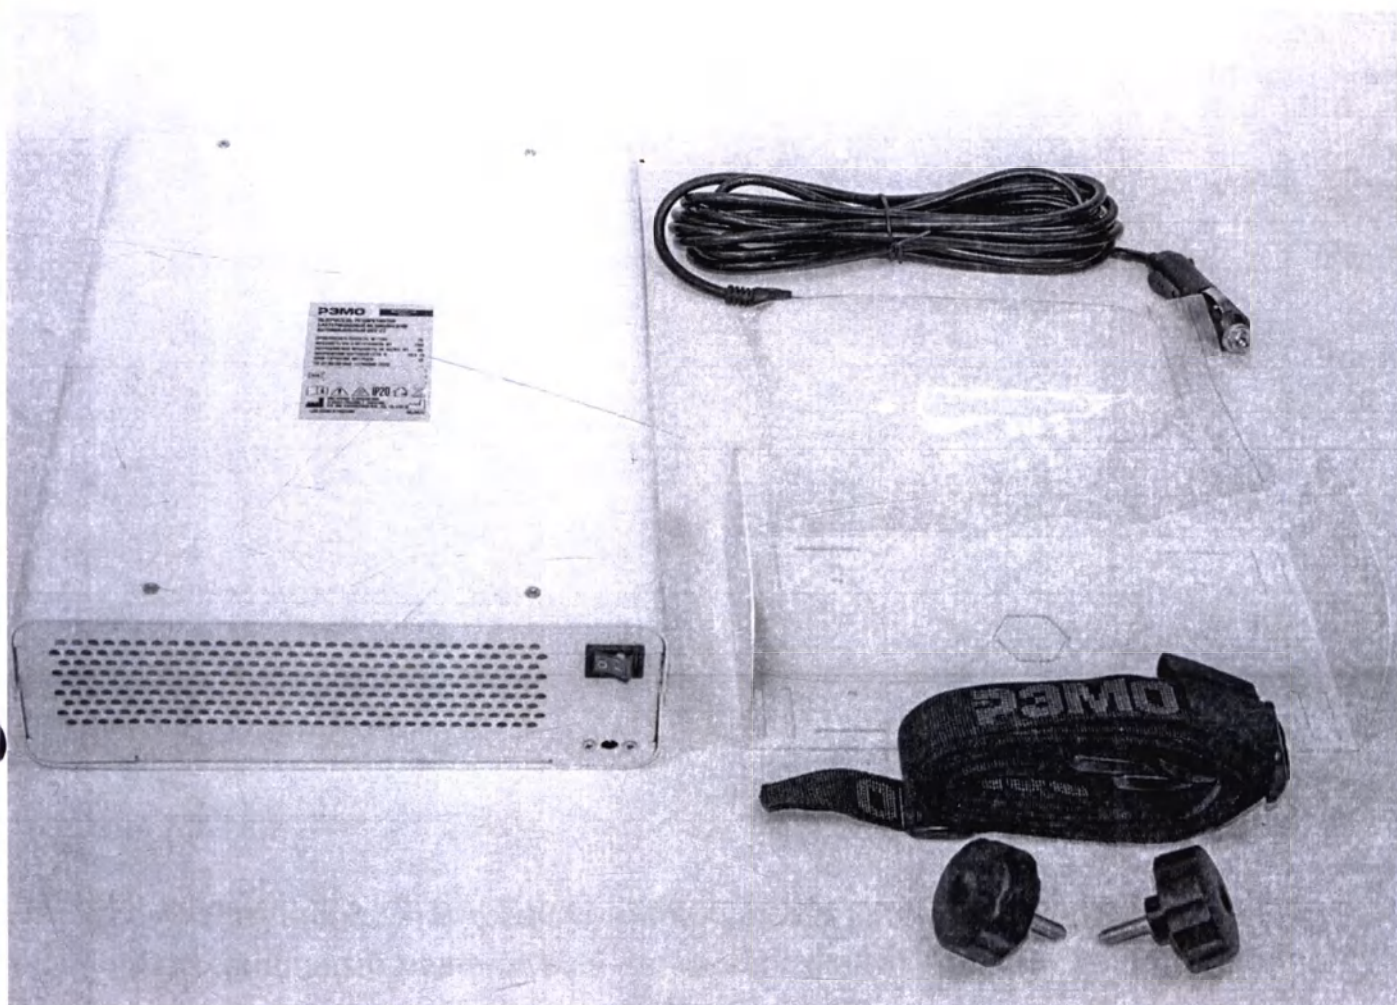


Рисунок 2.1 – Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

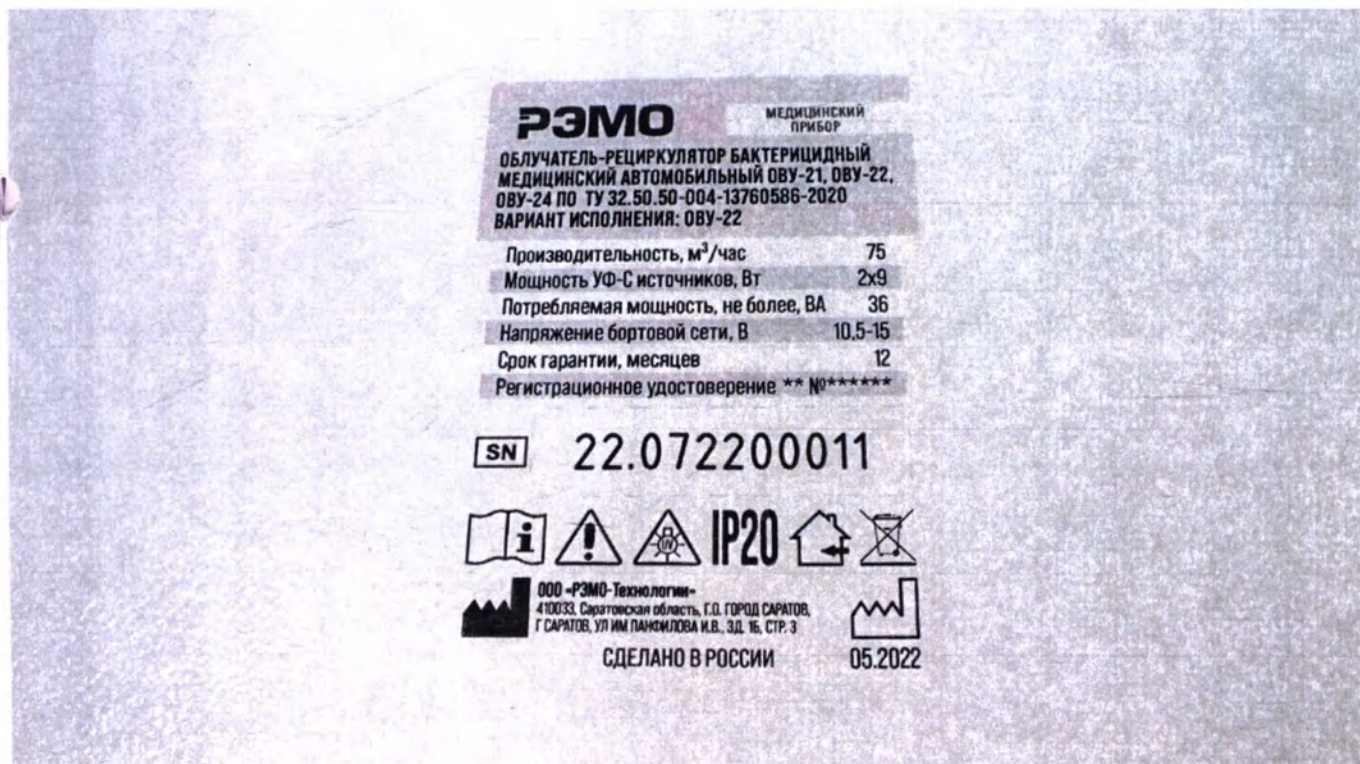


Рисунок 2.2 – С этикеткой Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

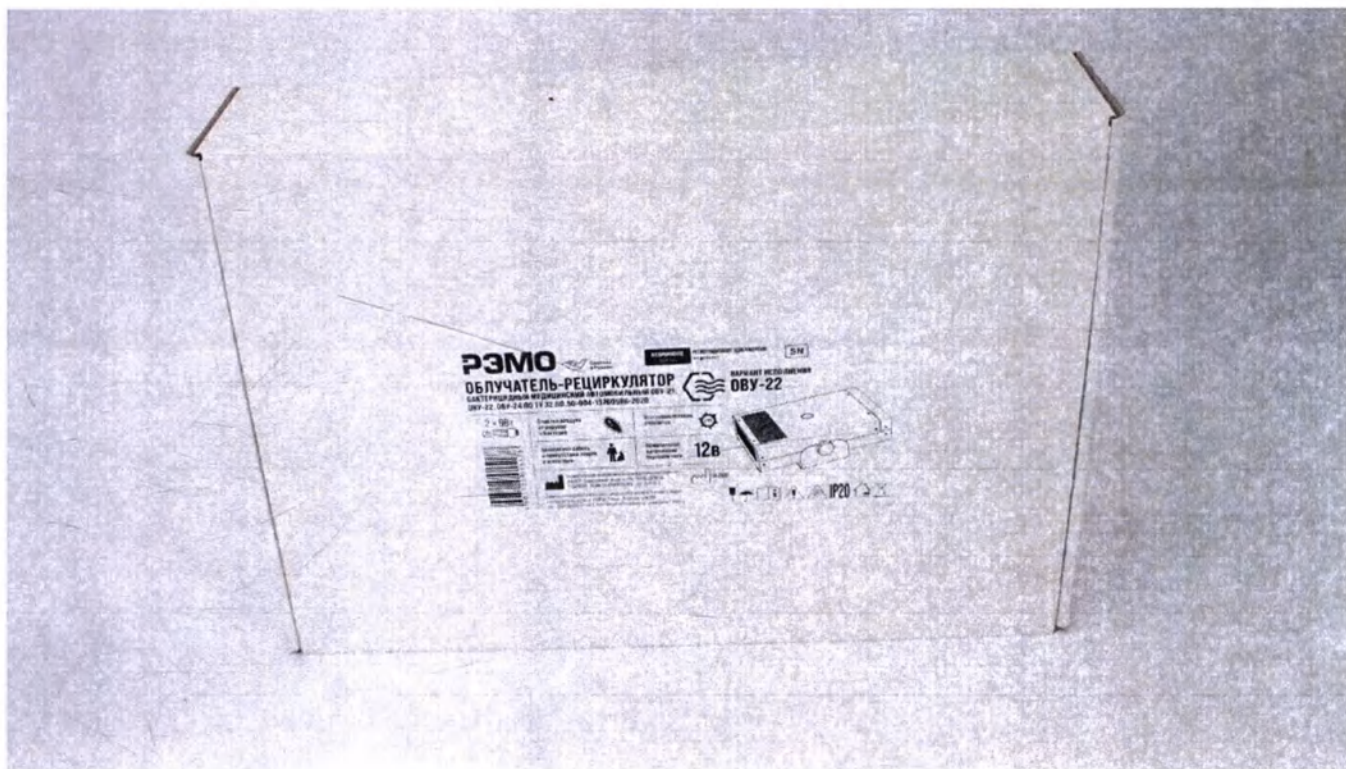


Рисунок 2.3 – В транспортной упаковке Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-22 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

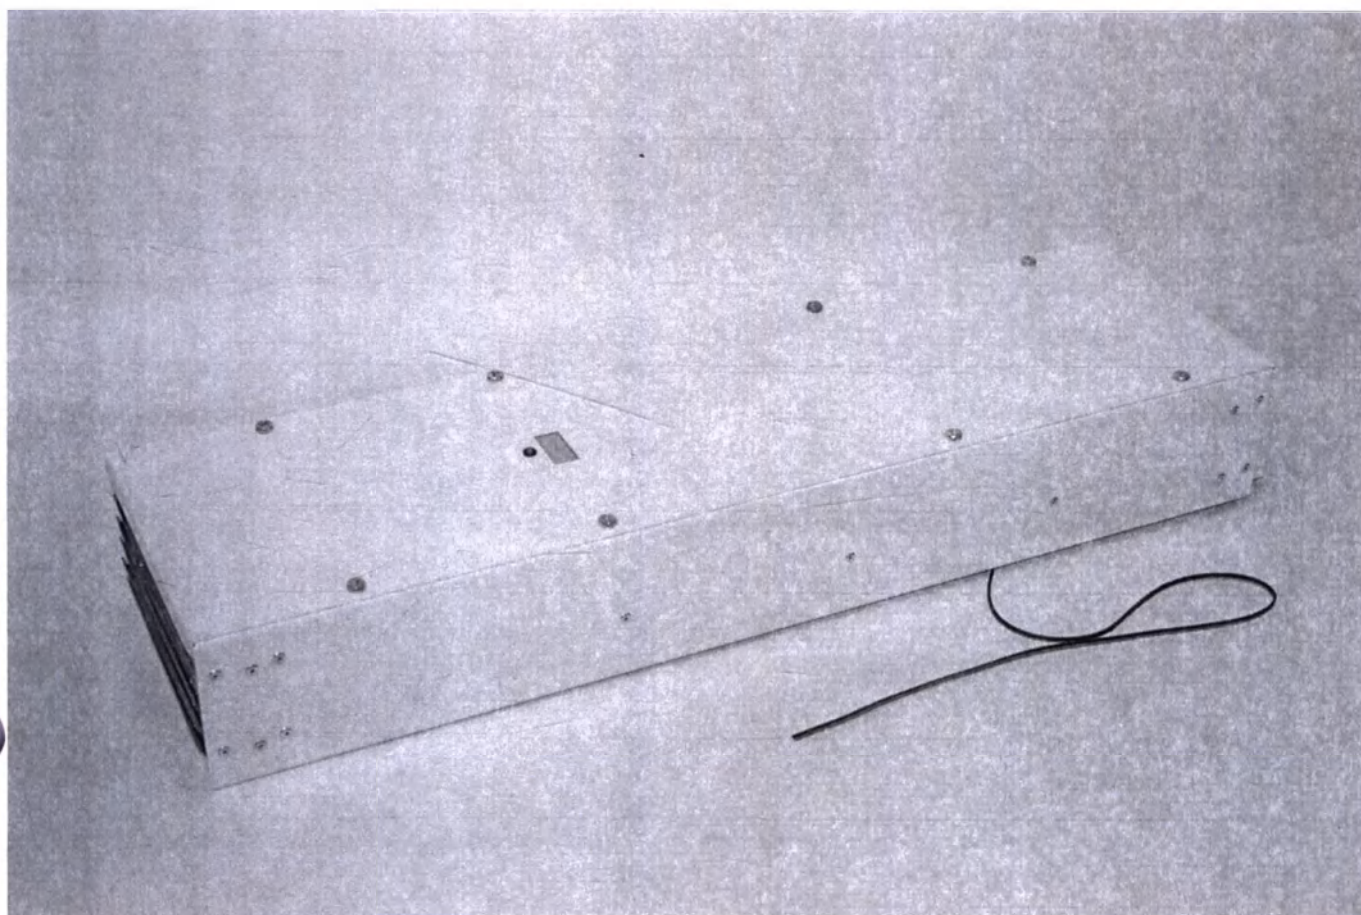


Рисунок 3.1 – Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

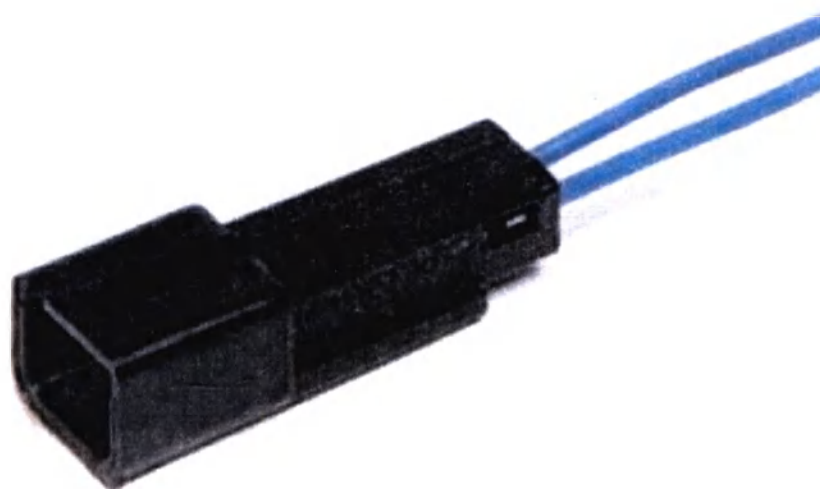


Рисунок 3.2 – Колодка штыревая



Рисунок 3.3 – Комплект метизов



Рисунок 3.4 – С этикеткой Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020



Рисунок 3.5 – В транспортной упаковке Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский автомобильный ОВУ-24 по ТУ 32.50.50-004-13760586-2020

Прошито и скреплено печатью
количество 8 (восемь) листов

Генеральный директор
ООО «РЭМО-ТЕХНОЛОГИИ»

_____/ А.И. Волошин /

Подпись

ФИО

