



www.neurosoft.com, info@neurosoft.com

Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99

Факс: +7 4932 24-04-35

Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5



**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей,
необходимых для его применения по назначению**

**«Полиграф респираторный «Снорлекс»
по ТУ 26.60.12-090-13218158-2022»**



Общий вид медицинского изделия «Полиграф респираторный «Снорлекс»»




Блок электронный «Снорлекс», NS090201.001-010, производства ООО «Нейрософт», Россия



Датчик пульсоксиметрический многоразовый, взрослый, NS090352.001, производства ООО «Нейрософт», Россия




Датчик пульсоксиметрический многоразовый, детский, NS090352.002, производства ООО «Нейрософт», Россия

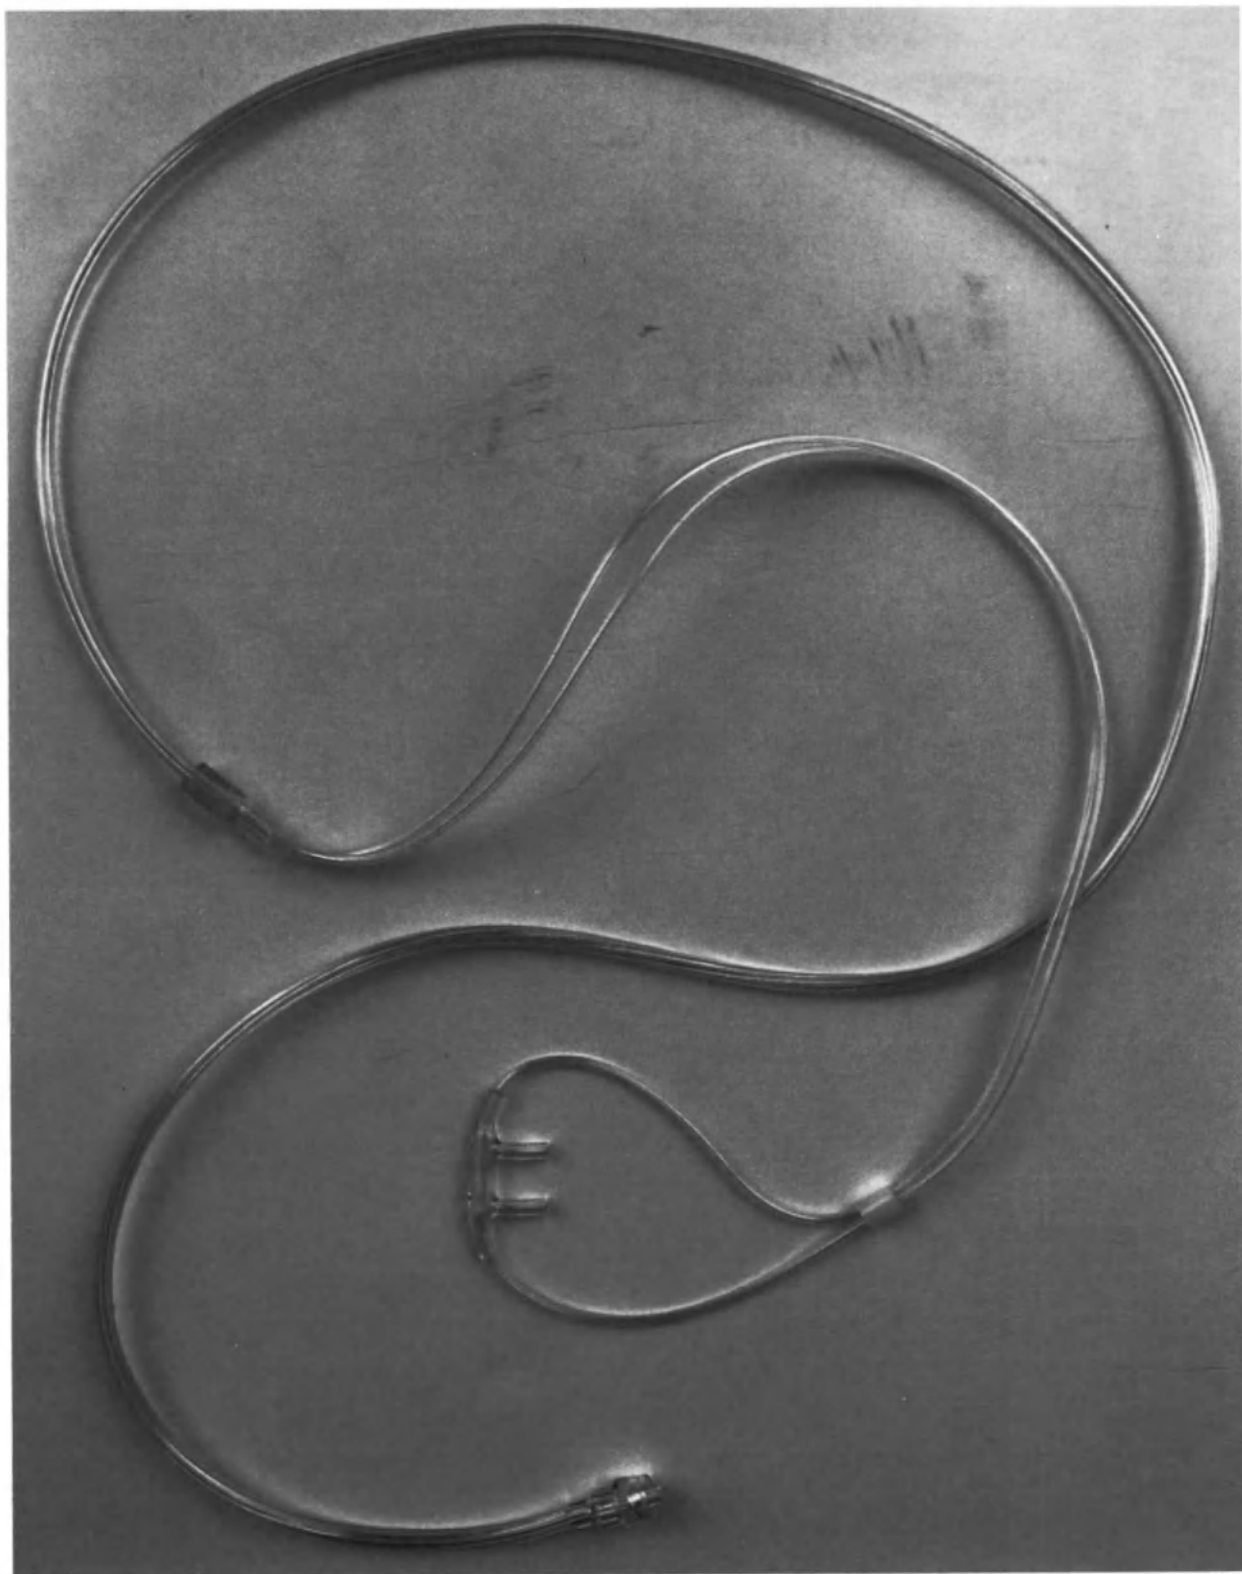


Канюля назальная, взрослая, NS990221.005, ООО «Нейрософт», Россия



Изделия для дыхательной и кислородной терапии APREXMED: Канюля кислородная назальная, размер S, артикул 0109-00-01, Апексмед Интернэшнл Б.В. Нидерланды, РУ №ФСЗ 2011/10188

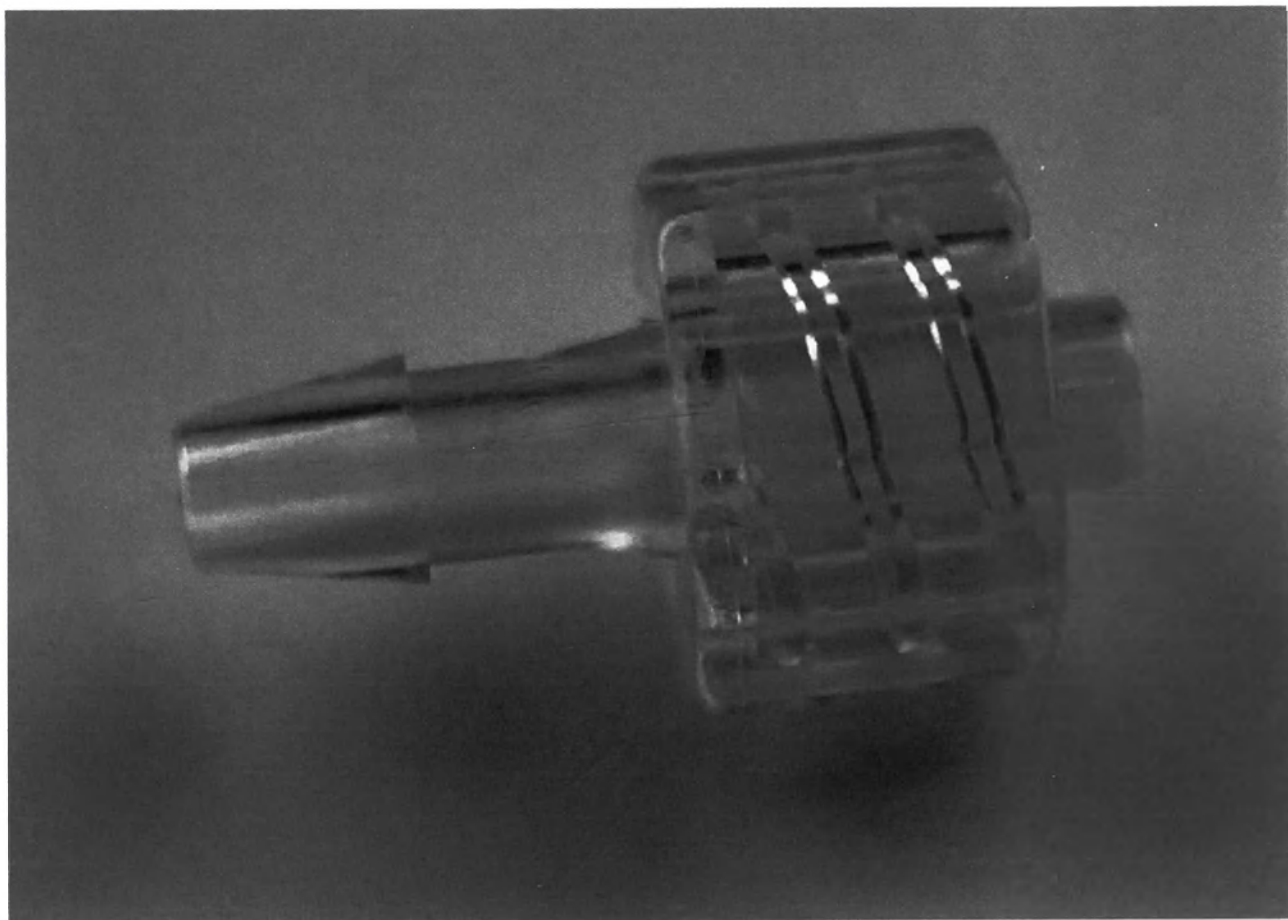


Переходник для канюли, арт. ААН10090, ПРОМЕПЛА С.А.М., Монако

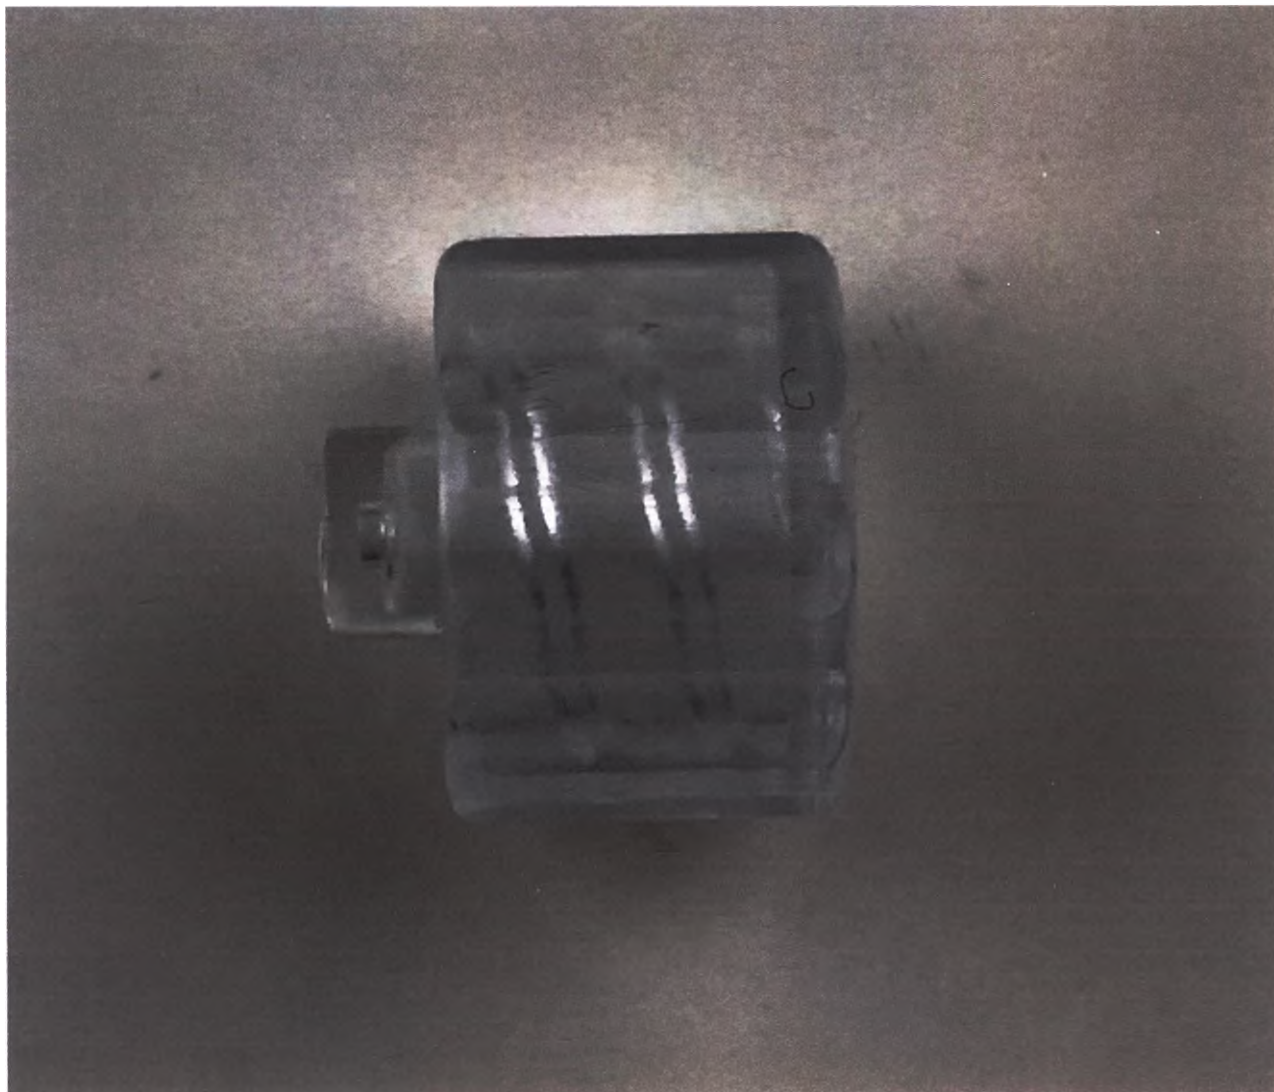

Заглушка для разъема канюли, MTLLP-9, Нордсон Медикал, США



Пластырь гипоаллергенный медицинский Transpore White, 5 см x 9,1 м, артикул 1534-2,
«3M Deutschland GmbH, Health Care Business», Германия

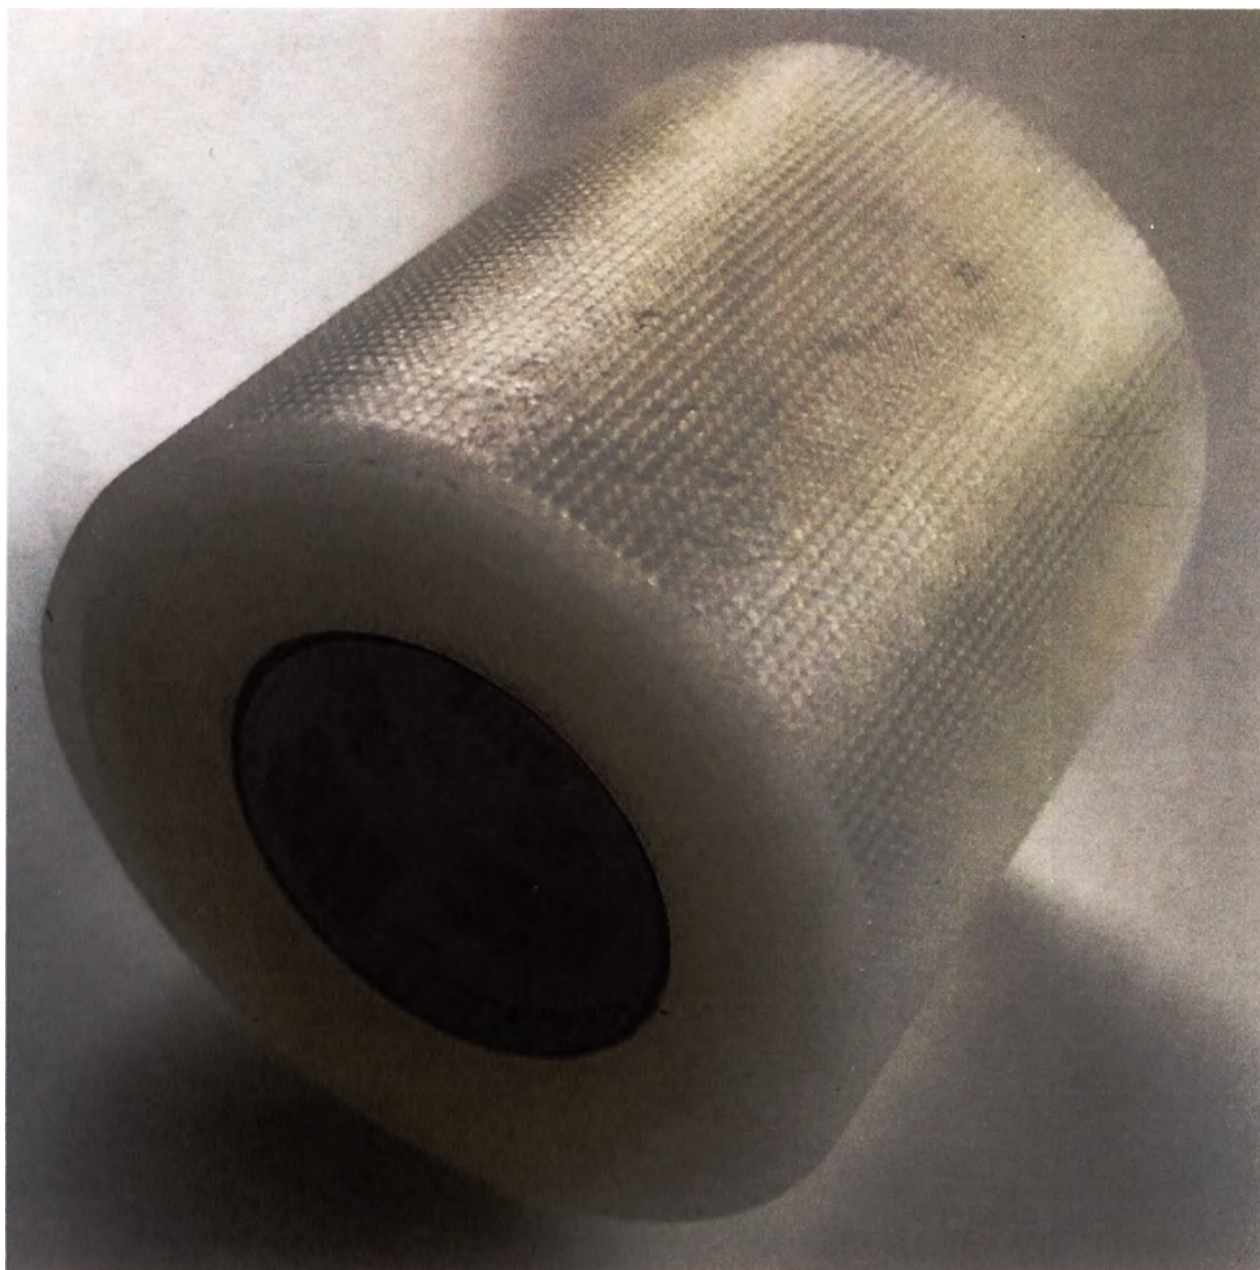

Средства перевязочные и фиксирующие Transpore, 5 см х 9,1 м, артикул.1527-2,
«3M Deutschland GmbH, 3M Health Care Business», Германия




Датчик экскурсии и положения тела, NS090357.001, производства ООО «Нейрософт», Россия





Кабель для индукционного ремня, арт. M0301008-0731, Qingdao Bright Medical Manufacturing Co., Ltd., Китай



Индукционный ремень многоразовый, арт. M0706029, Qingdao Bright Medical Manufacturing Co., Ltd., Китай

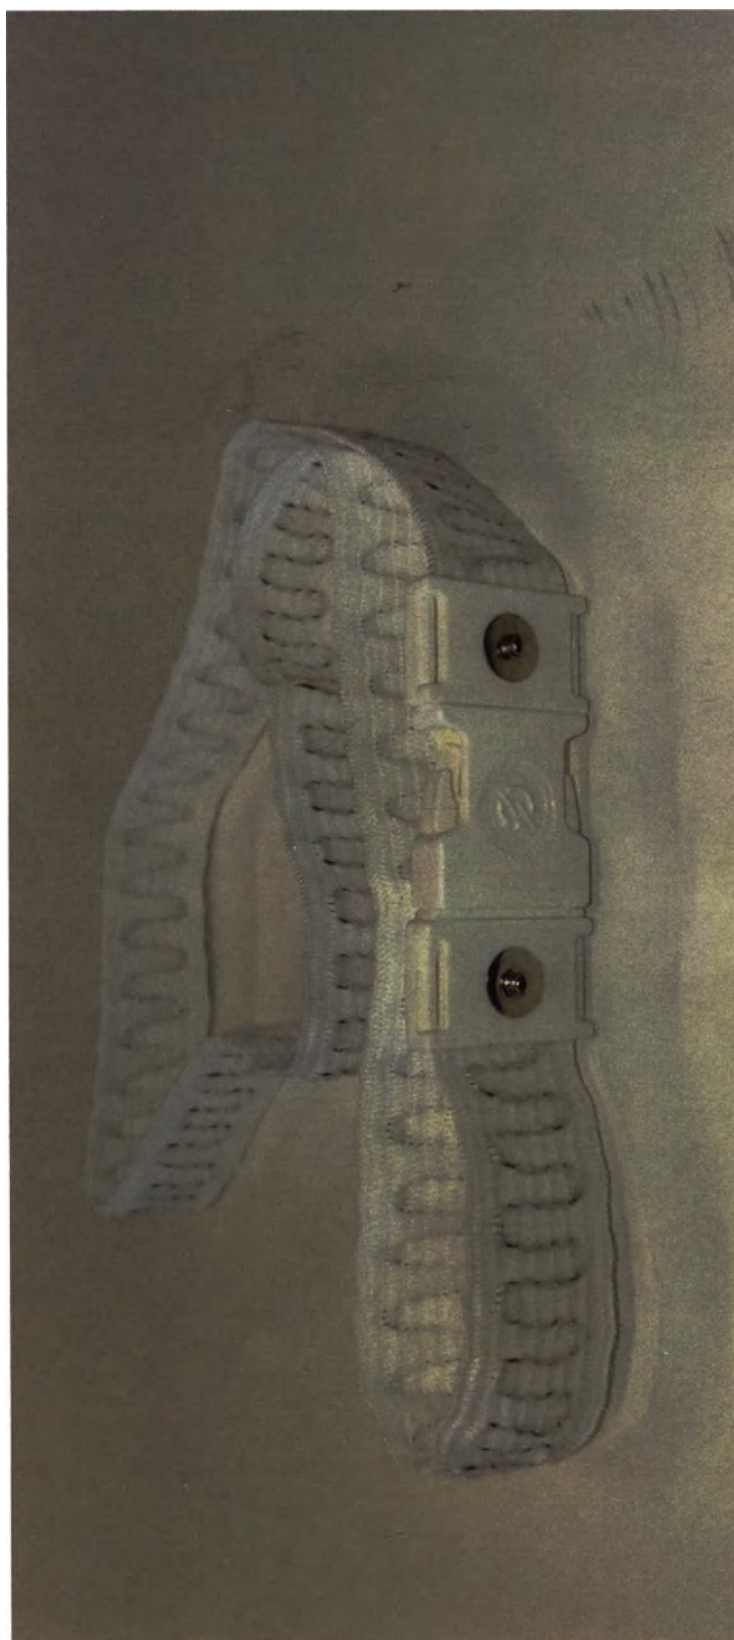

Индукционный ремень одноразовый, арт. M0706030, Qingdao Bright Medical Manufacturing Co., Ltd., Китай

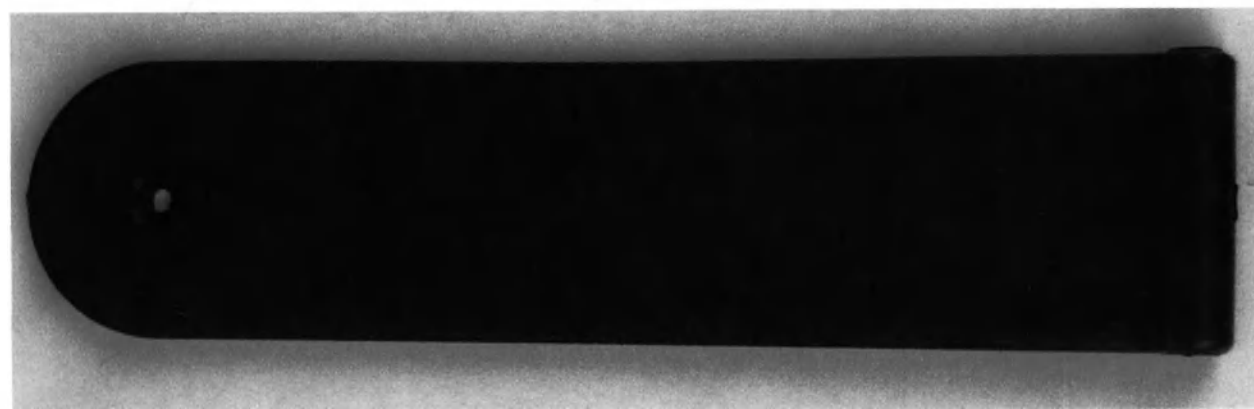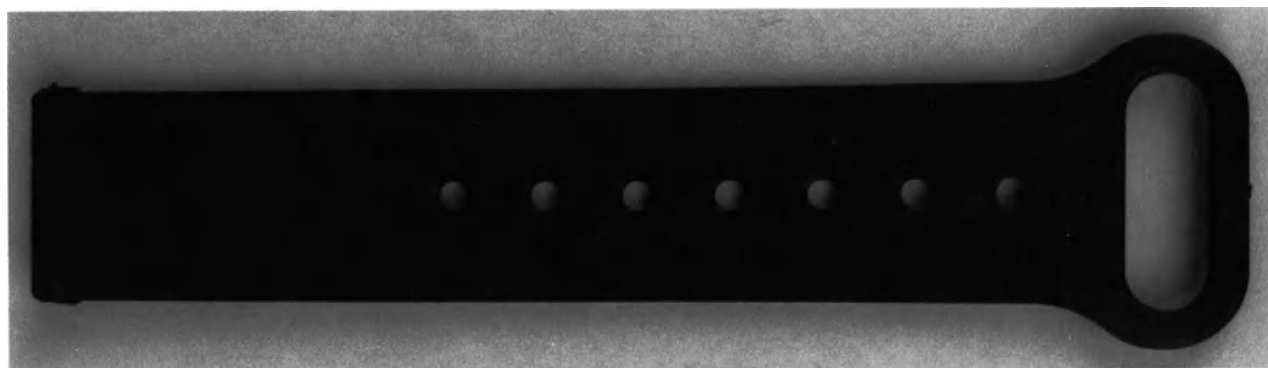

Комплект деталей запасного ремешка, NS090998.001, ООО «Нейрософт», Россия

 **Transcend**[®]

PREMIUM
400x

microSDHC™ UHS-I 

8GB

60 Up to
MB/s

Great for
FULL HD
Recording

micro
SD 
UHS-I
CLASS 



For SDHC devices only. Maximum transfer speed requires UHS-I compatible device.

Карта памяти micro-SD, Micro-SD Class 2-16, не менее 2 Гб, не более 32 Гб, Transcend, Тайвань



Кабель USB, NS090103.001, ООО «Нейрософт», Россия



Адаптер USB, поддержка micro-SD, поддержка карт класса 2-16, поддержка карт объемом от 2 до 32 Гб, Transcend USB, Тайвань




Элемент питания, типоразмер AAA: LR03, FR03; 1,5 В, Camelion, Китай



Аккумулятор, типоразмер AAA: HR03; 1,2 В, GP Rechargeable, Китай



Зарядное устройство для аккумуляторов, питание от сети 110/220/230/240 В, 50/60 Гц (в зависимости от характеристик сети электропитания у пользователя); не менее двух мест для одновременной зарядки аккумуляторов типоразмера AAA (HR03), Camelion, Китай

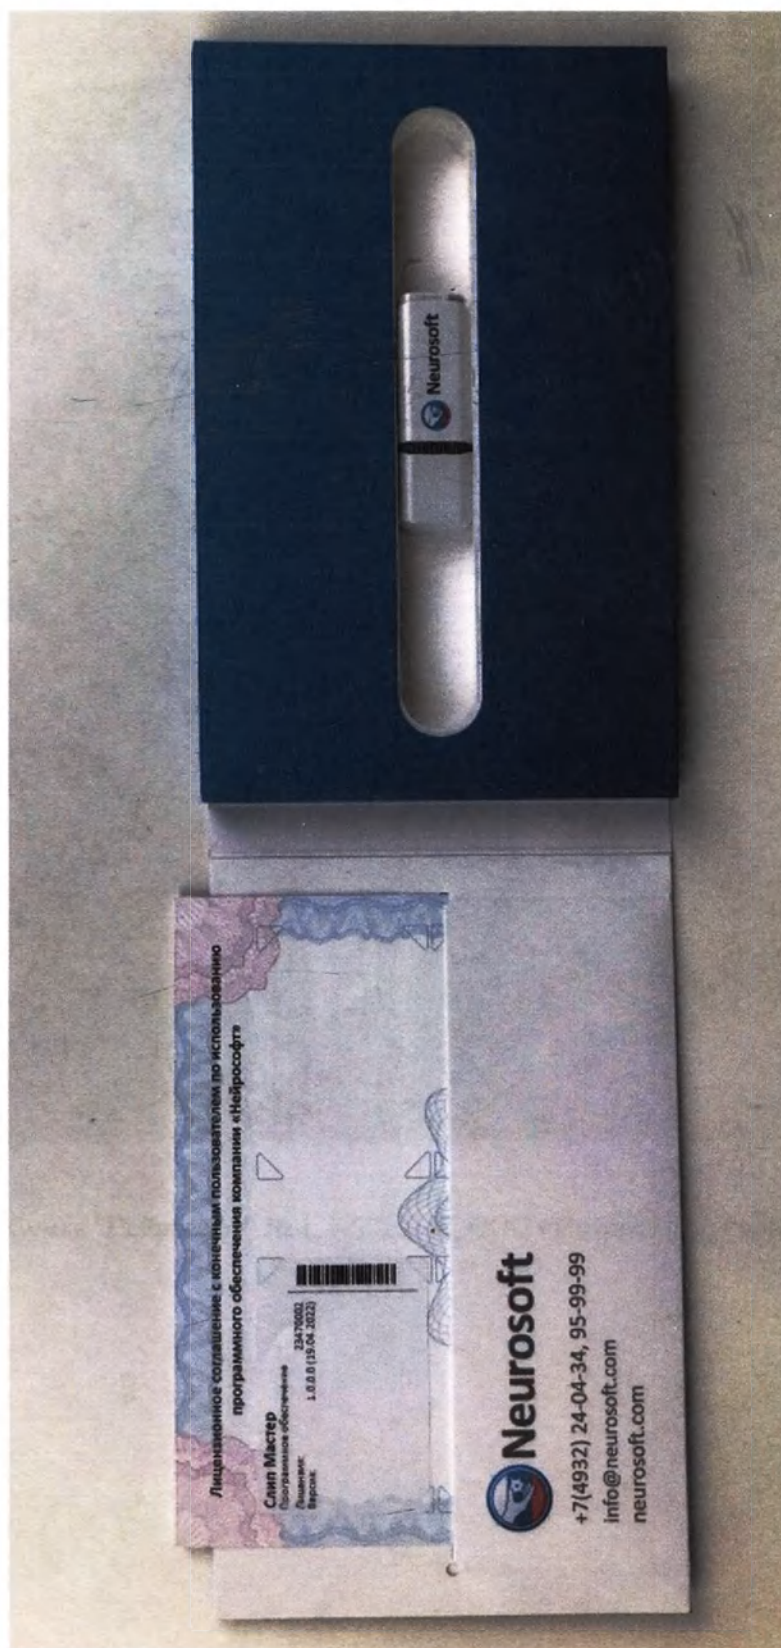


Установочный комплект программы для ЭВМ «Слип Мастер», NS242739, ООО «Нейрософт»,
Россия.
Лицензия на использование программы для ЭВМ «Слип Мастер», NS242738, ООО «Нейрософт»,
Россия.

Комплект упаковочной тары, NS002901.004, ООО «Нейрософт», Россия:



Сумка "Нейрософт" № 1, NS216168, ООО «Нейрософт», Россия

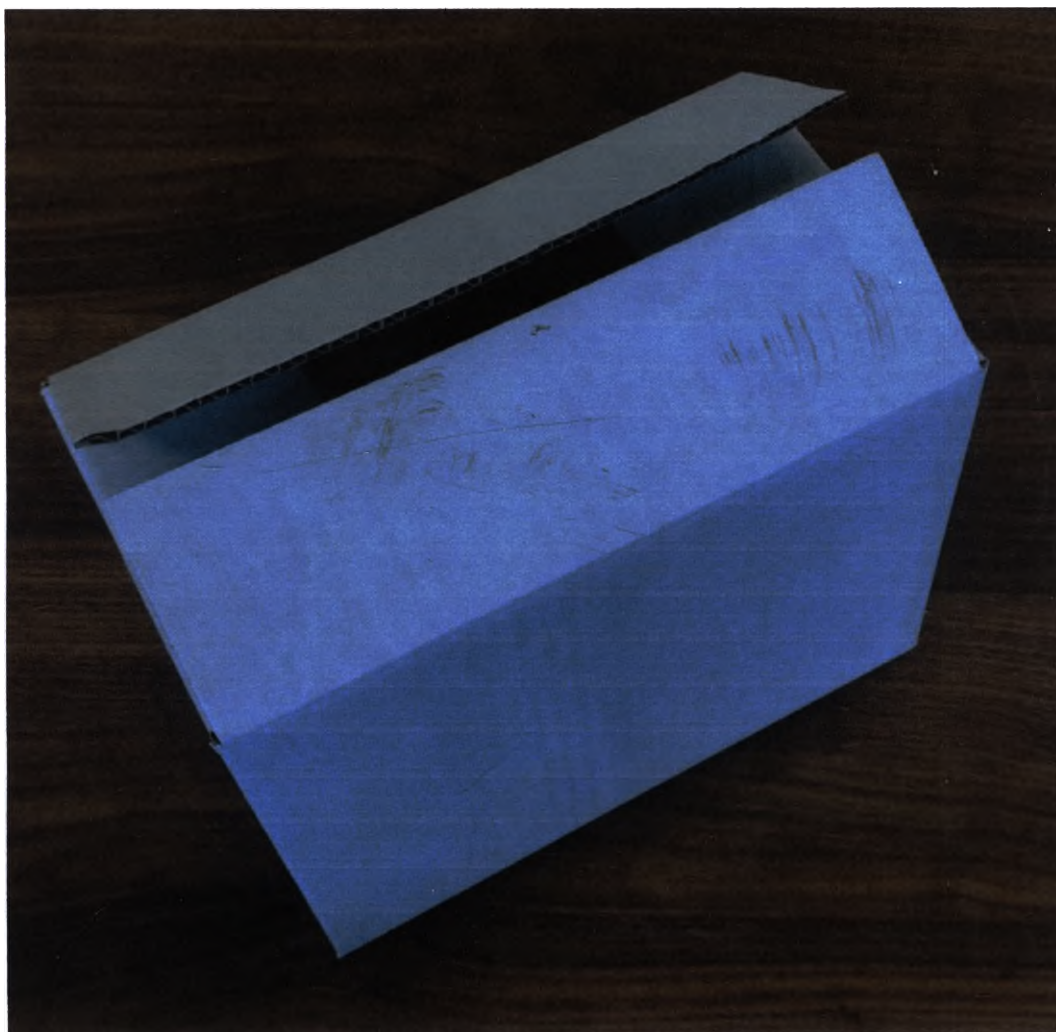

Гофрокороб Т-23, белый



Системный блок: «Функциональный» или «Элитный», процессор Intel Core i5 и выше; оперативная память 4 Гб и более; место на диске для программы 1,0 Гб; место на диске для хранения обследований 10 Гб и более; совместимость интерфейса с монитором DVI); количество USB-разъемов не менее 2, ООО «Нейрософт», Россия



Монитор, LCD 23'' и более; наличие крепления VESA; встроенный блок питания; разрешение экрана не менее 1920x1080, PHILIPS, Китай



Портативный компьютер, процессор – Intel Core i5 и выше; оперативная память - 4 Гб и выше; объем жесткого диска - 1 Тб и более; операционная система – Windows 8 и выше; диагональ – 17 дюймов и более, ACER, Китай



Принтер, лазерная или струйная печать; - скорость печати не менее 18 стр./мин; - максимальный формат печати A4; - интерфейс USB 2.0 и выше и/или встроенный модуль Wi-Fi, XEROX, Китай

ПРОШНУРОВАН
ПРОНУМЕРОВАН
С КРЕПОСЬЮ ПЕЧАТЮ
С ДИСТАХ
ПРЕЗИДЕНТ ООО «НЕЙРОСОФТ»
А.Б. ЖУБИН



Полиграф респираторный «Снорлекс» по ТУ 26.60.12-090-13218158-2022 Маркировка и упаковка

На рисунках ниже приведены примеры макетов маркировок, фотографические изображения их, фотографические изображения упаковок групп однородных изделий, а также программного обеспечения, входящих в состав Полиграфа респираторного «Снорлекс» (за исключением входящих в состав самостоятельных медицинских изделий, имеющих собственные регистрационные удостоверения и маркировка которых приведена в соответствующих регистрационных досье). Маркировка изделий наносится непосредственно на корпус изделия или его несъемный кабель, маркировка программного обеспечения – на его упаковку

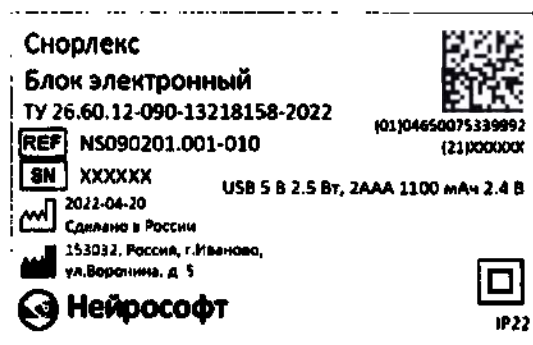


Рисунок 1 - Макет маркировки блока электронного «Снорлекс»

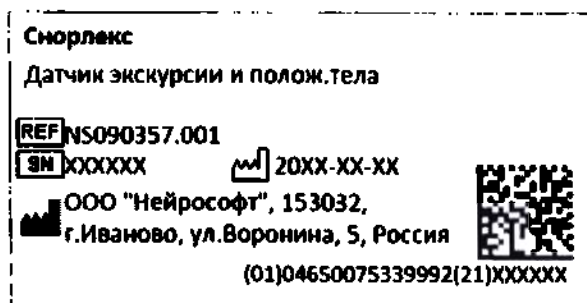


Рисунок 2 – Макет маркировки датчика экскурсии и положения тела

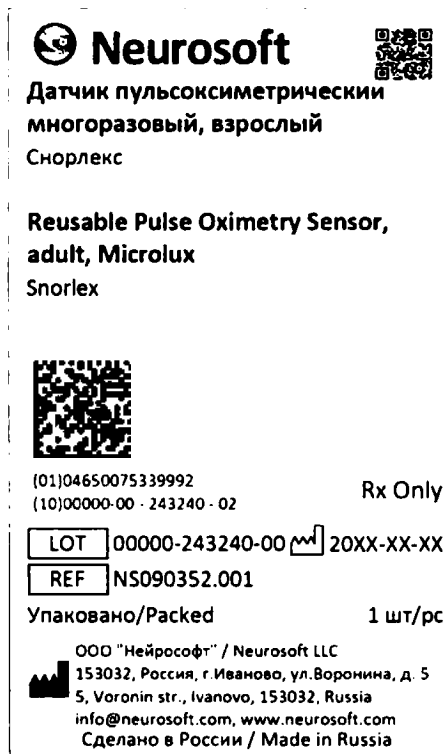


Рисунок 3 – Макет маркировки индивидуальной упаковки датчика пульсоксиметрического многоцветного

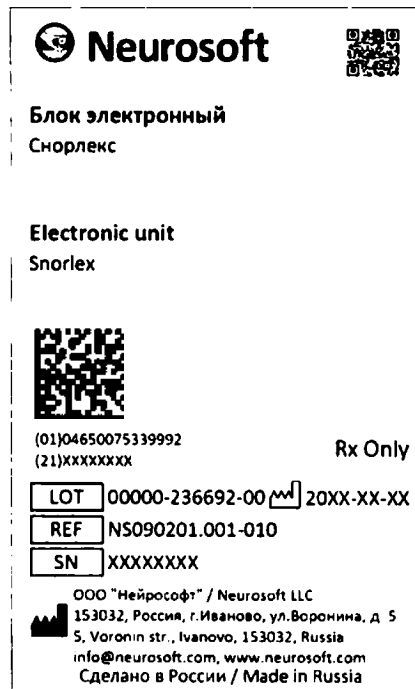


Рисунок 4 – Макет маркировки индивидуальной упаковки блока электронного «Снорлекс»

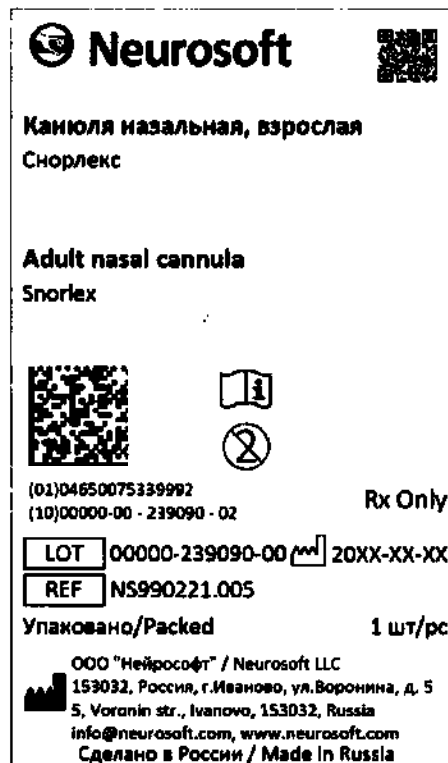


Рисунок 5 – Макет маркировки индивидуальной упаковки канюли назальной, взрослой



Рисунок 6 – Макет маркировки индивидуальной упаковки комплекта деталей запасного ремешка



Рисунок 7 - Макет маркировки системного блока персонального компьютера



Рисунок 8 - Лицензионное соглашение по использованию ПО компании «Нейрософт»

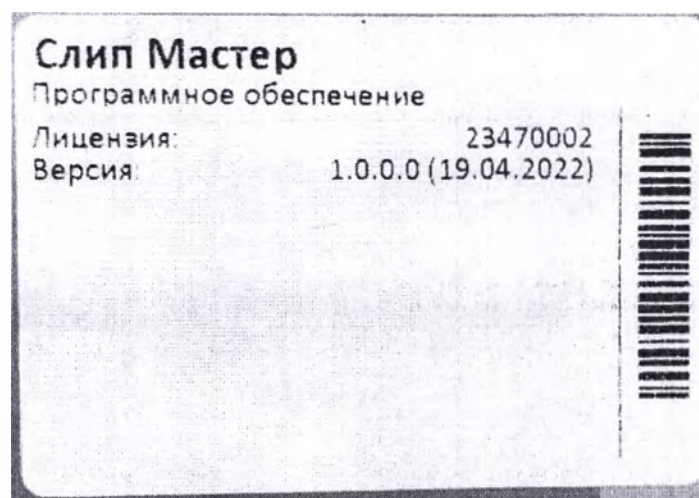


Рисунок 9 - Макет маркировки ПО «Слип-Мастер», размещаемой на упаковку ПО



Рисунок 10 – Образец упаковки ПО компании «Нейрософт»

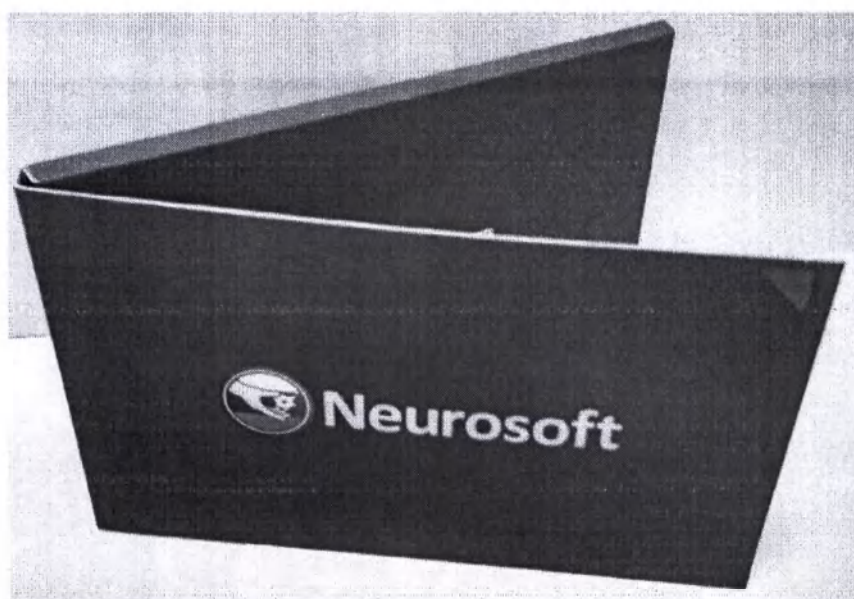


Рисунок 11 - Фотографическое изображение индивидуальной упаковки программного обеспечения компании Нейрософт



Президент ООО «Нейрософт»

М.П.

А. Б. Шубин

