



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgA – ИФА – БЕСТ) по ТУ 9398-169-23548172-2009»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

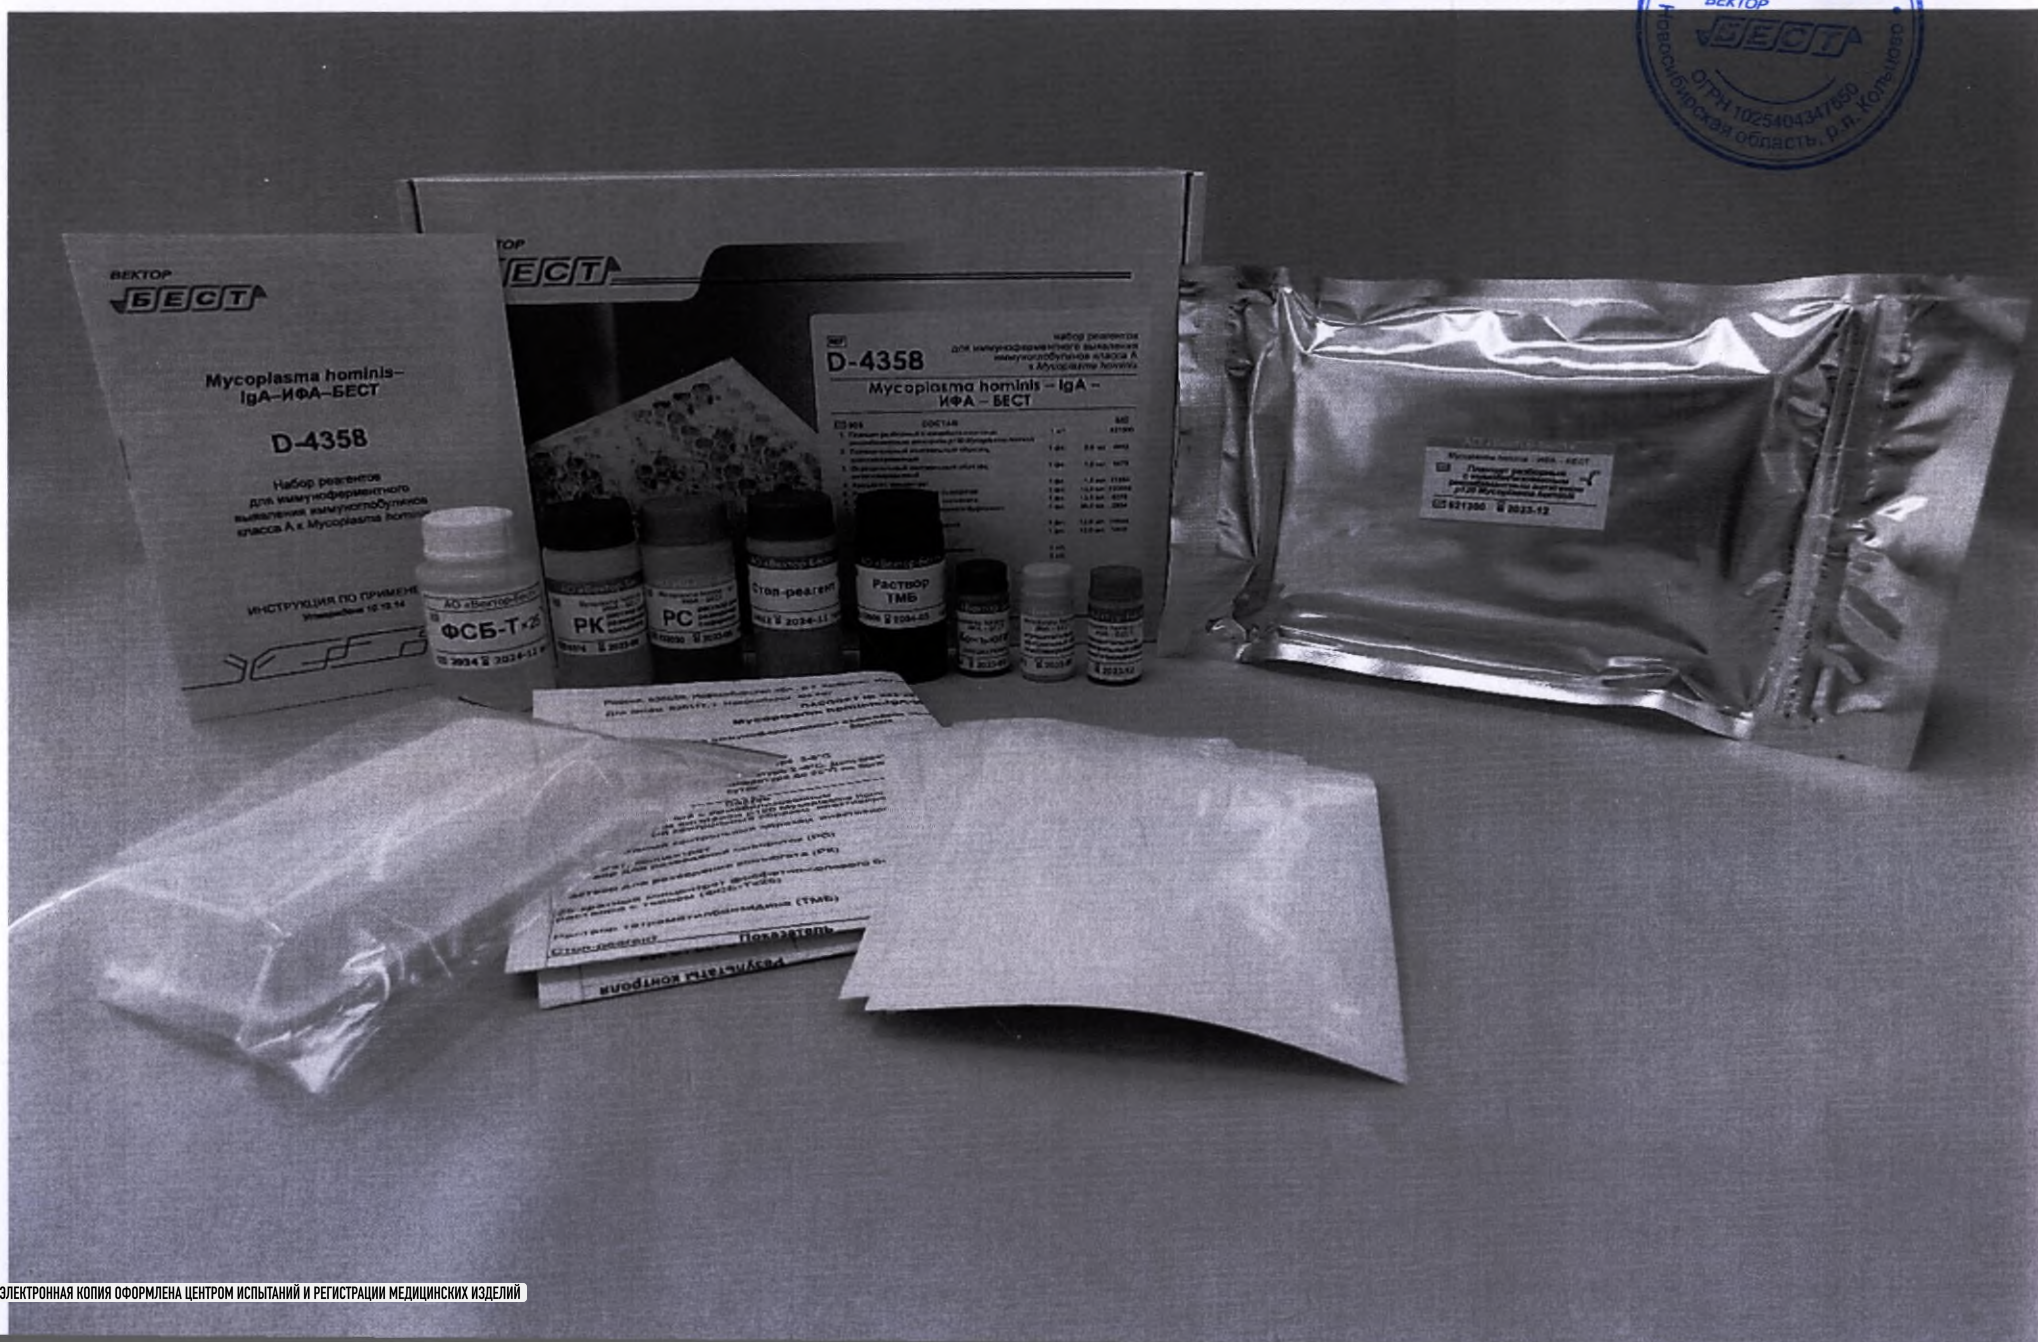

ВЕКТОР

БЕСТ

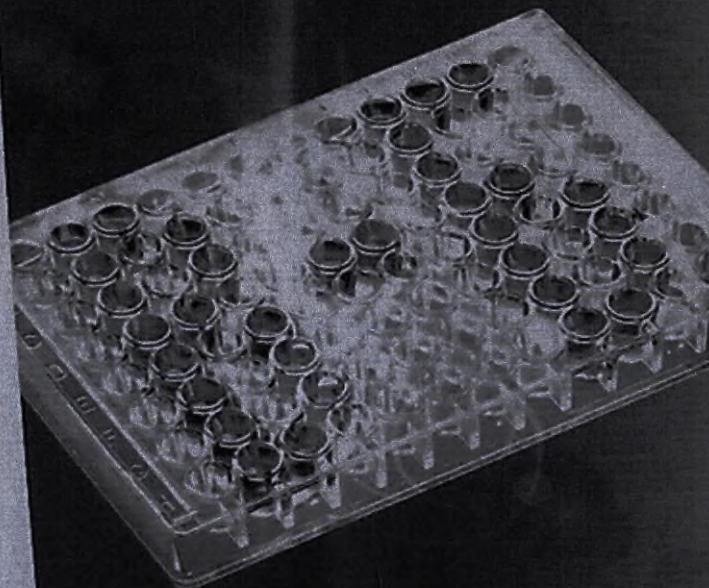

REF

D-4358

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса А
к *Mycoplasma hominis*

Mycoplasma hominis – IgA –
ИФА – БЕСТ

LOT 909

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном р120 <i>Mycoplasma hominis</i>	1 шт.	621300
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	0,5 мл 4492
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,0 мл 3679
4. Конъюгат, концентрат	1 фл.	1,5 мл 11584
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	13,0 мл 733030
6. Раствор для разведения конъюгата	1 фл.	13,0 мл 5376
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл 2934
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл 10508
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл 1412
Принадлежности:		
Плёнка для заклеивания планшета	3 шт.	
Ванночки для реагентов	2 шт.	
Наконечники для пипеток	16 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgA – ИФА – БЕСТ) по ТУ 9398-169-23548172-2009» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



ВЕКТОР

БЕСТ

REF **D-4358**

Σ 12×8

LOT **909**

ТУ 9398-169-23548172-2009

РУ № ФСР 2009/05945 от 10.02.2017

2022-03-18

2023-03-18

***Mycoplasma hominis* – IgA – ИФА – БЕСТ**

IVD



43581803230090900136

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgA – ИФА – БЕСТ) по ТУ 9398-169-23548172-2009» №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2022 г.



АО «Вектор-Бест»
Mycoplasma hominis – ИФА – БЕСТ
IVD Планшет разборный
с иммобилизованным
рекомбинантным антигеном
p120 Mycoplasma hominis
LOT 621300 2023-12

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgA – ИФА – БЕСТ) по ТУ 9398-169-23548172-2009» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
102 2022 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к *Mycoplasma hominis* (*Mycoplasma hominis* – IgA – ИФА – БЕСТ) по ТУ 9398-169-23548172-2009» №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.



« 07 2022 г.»

