



Фотография коробки с ярлыком, по пункту 1.5.2 ТУ 9438-002-58261811-2008


На ярлыке указаны: наименование изготовителя и его товарный знак; наименование набора; обозначение настоящих технических условий; дата выпуска; сведения о приемке набора отделом технического контроля.

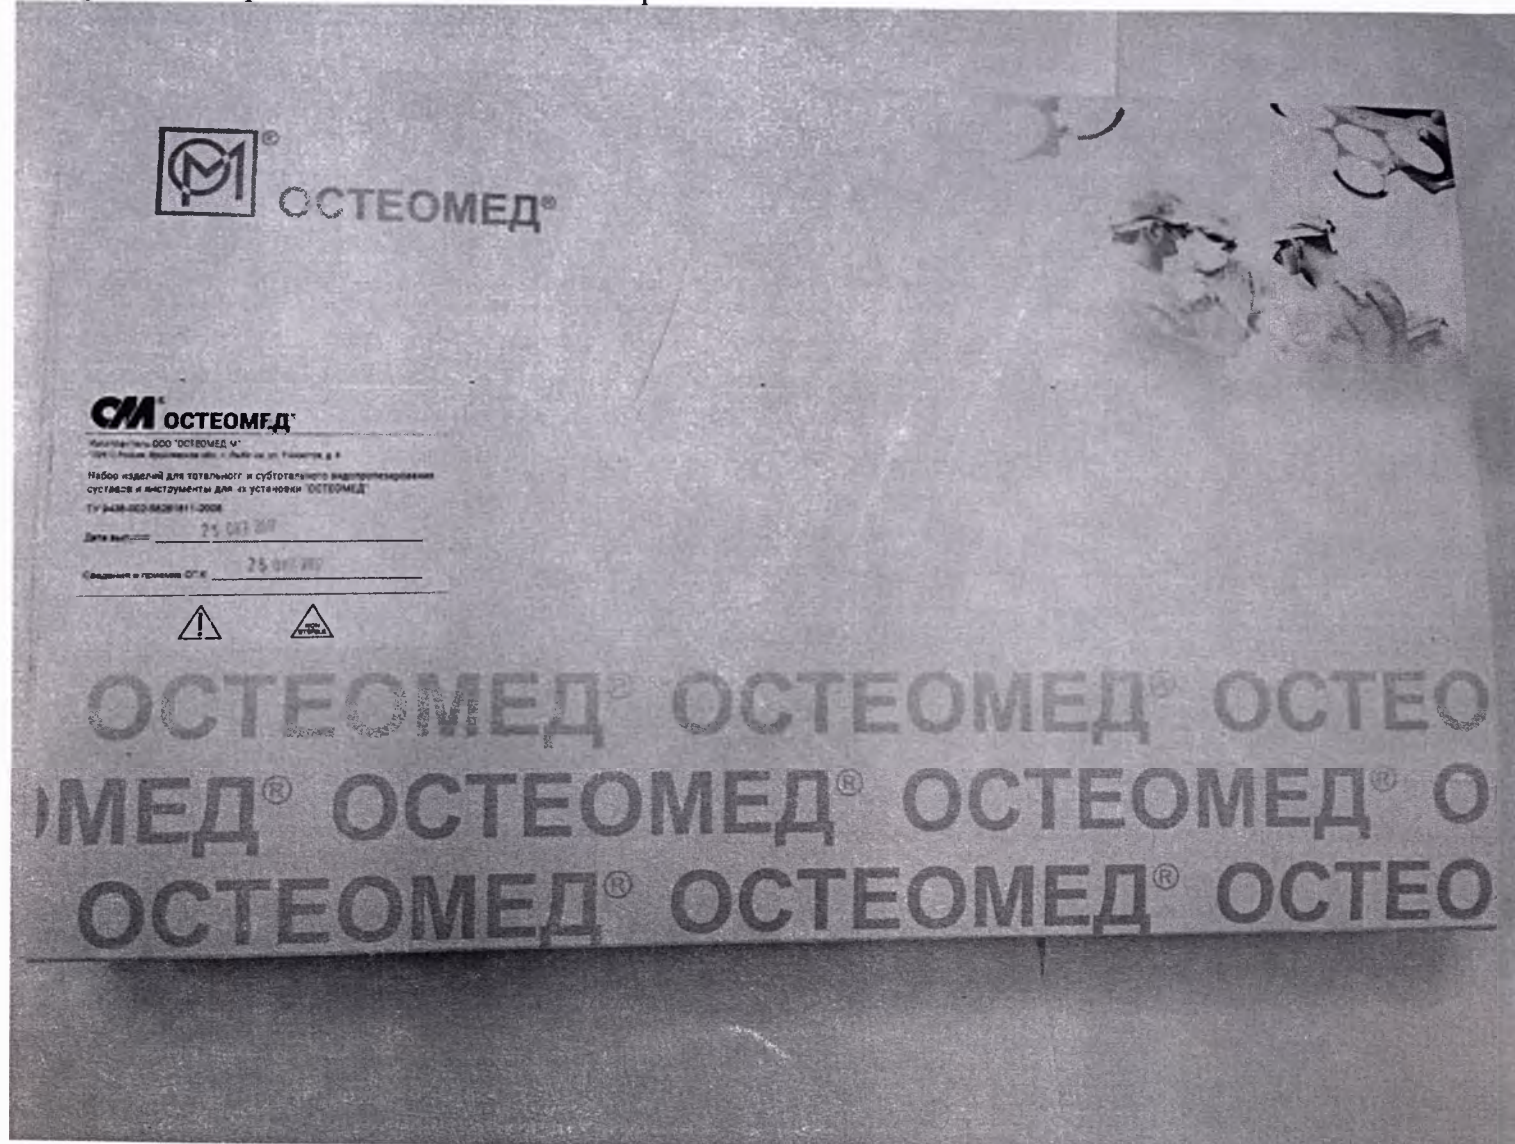

Фотография открытой коробки, по ТУ 9438-002-58261811-2008

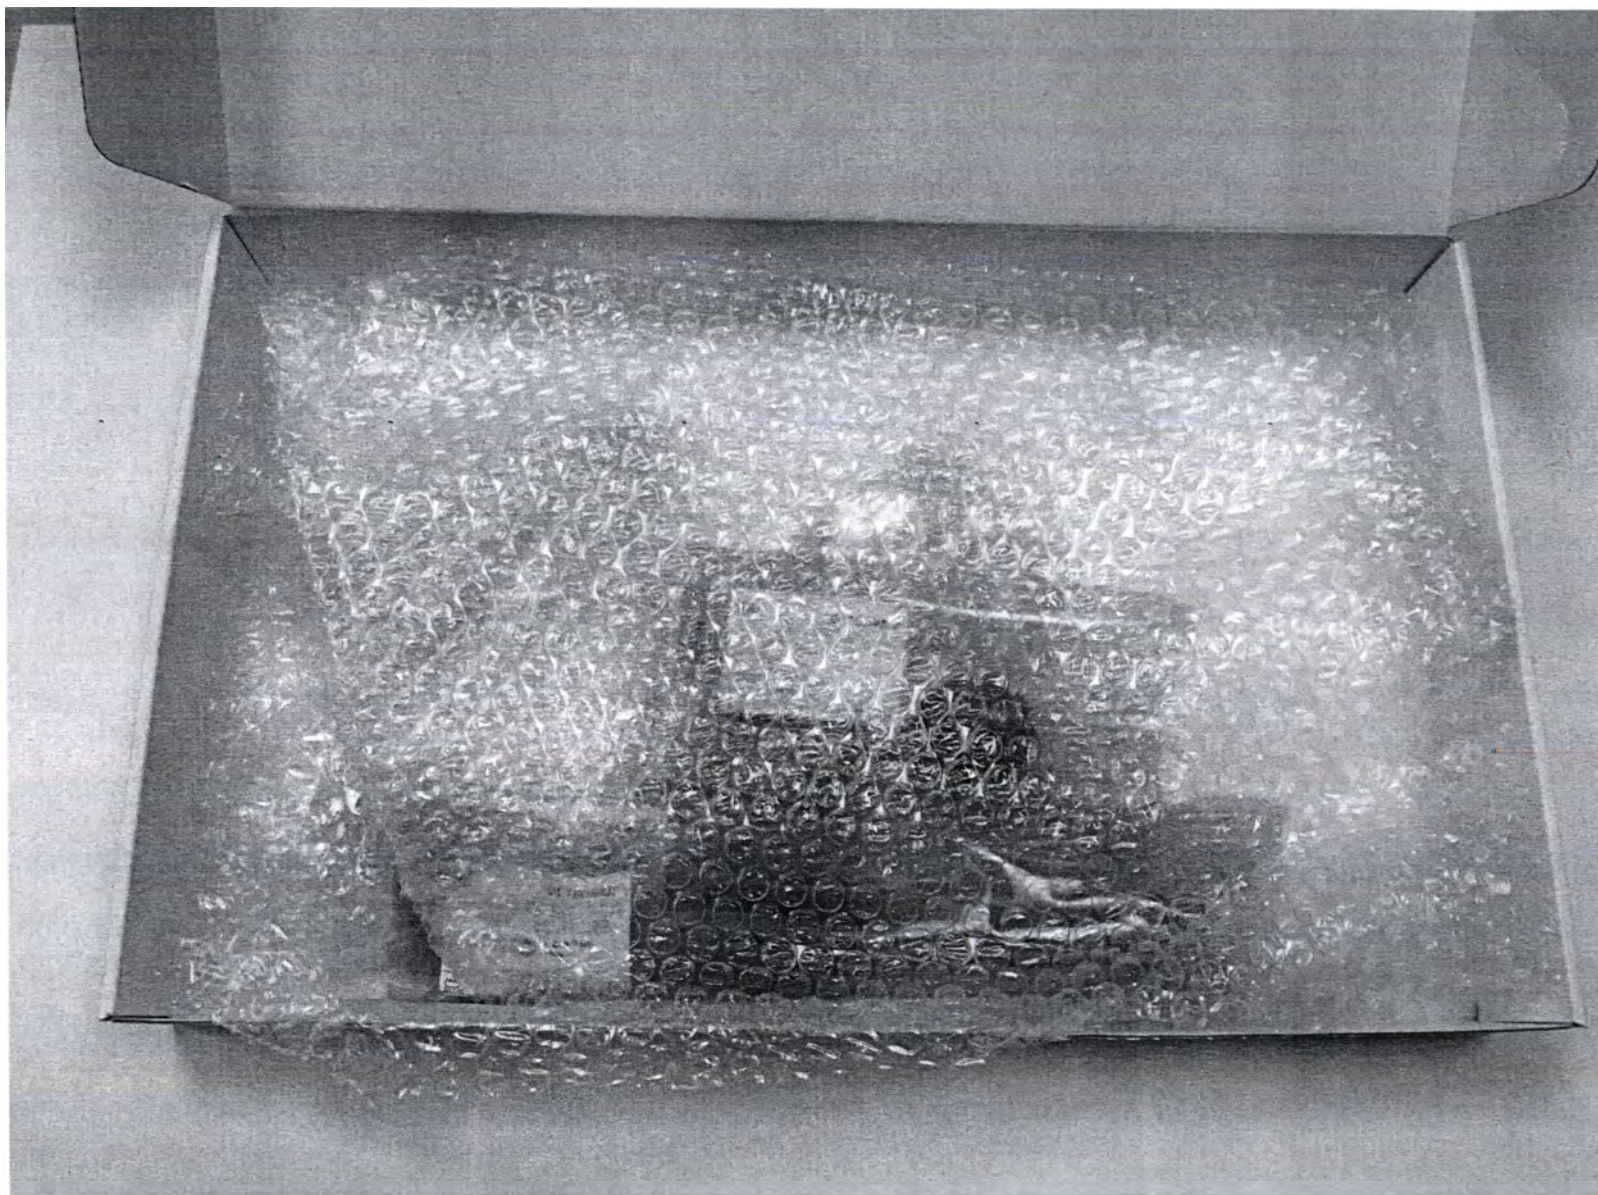


Фотография изделий в коробке, по ТУ 9438-002-58261811-2008

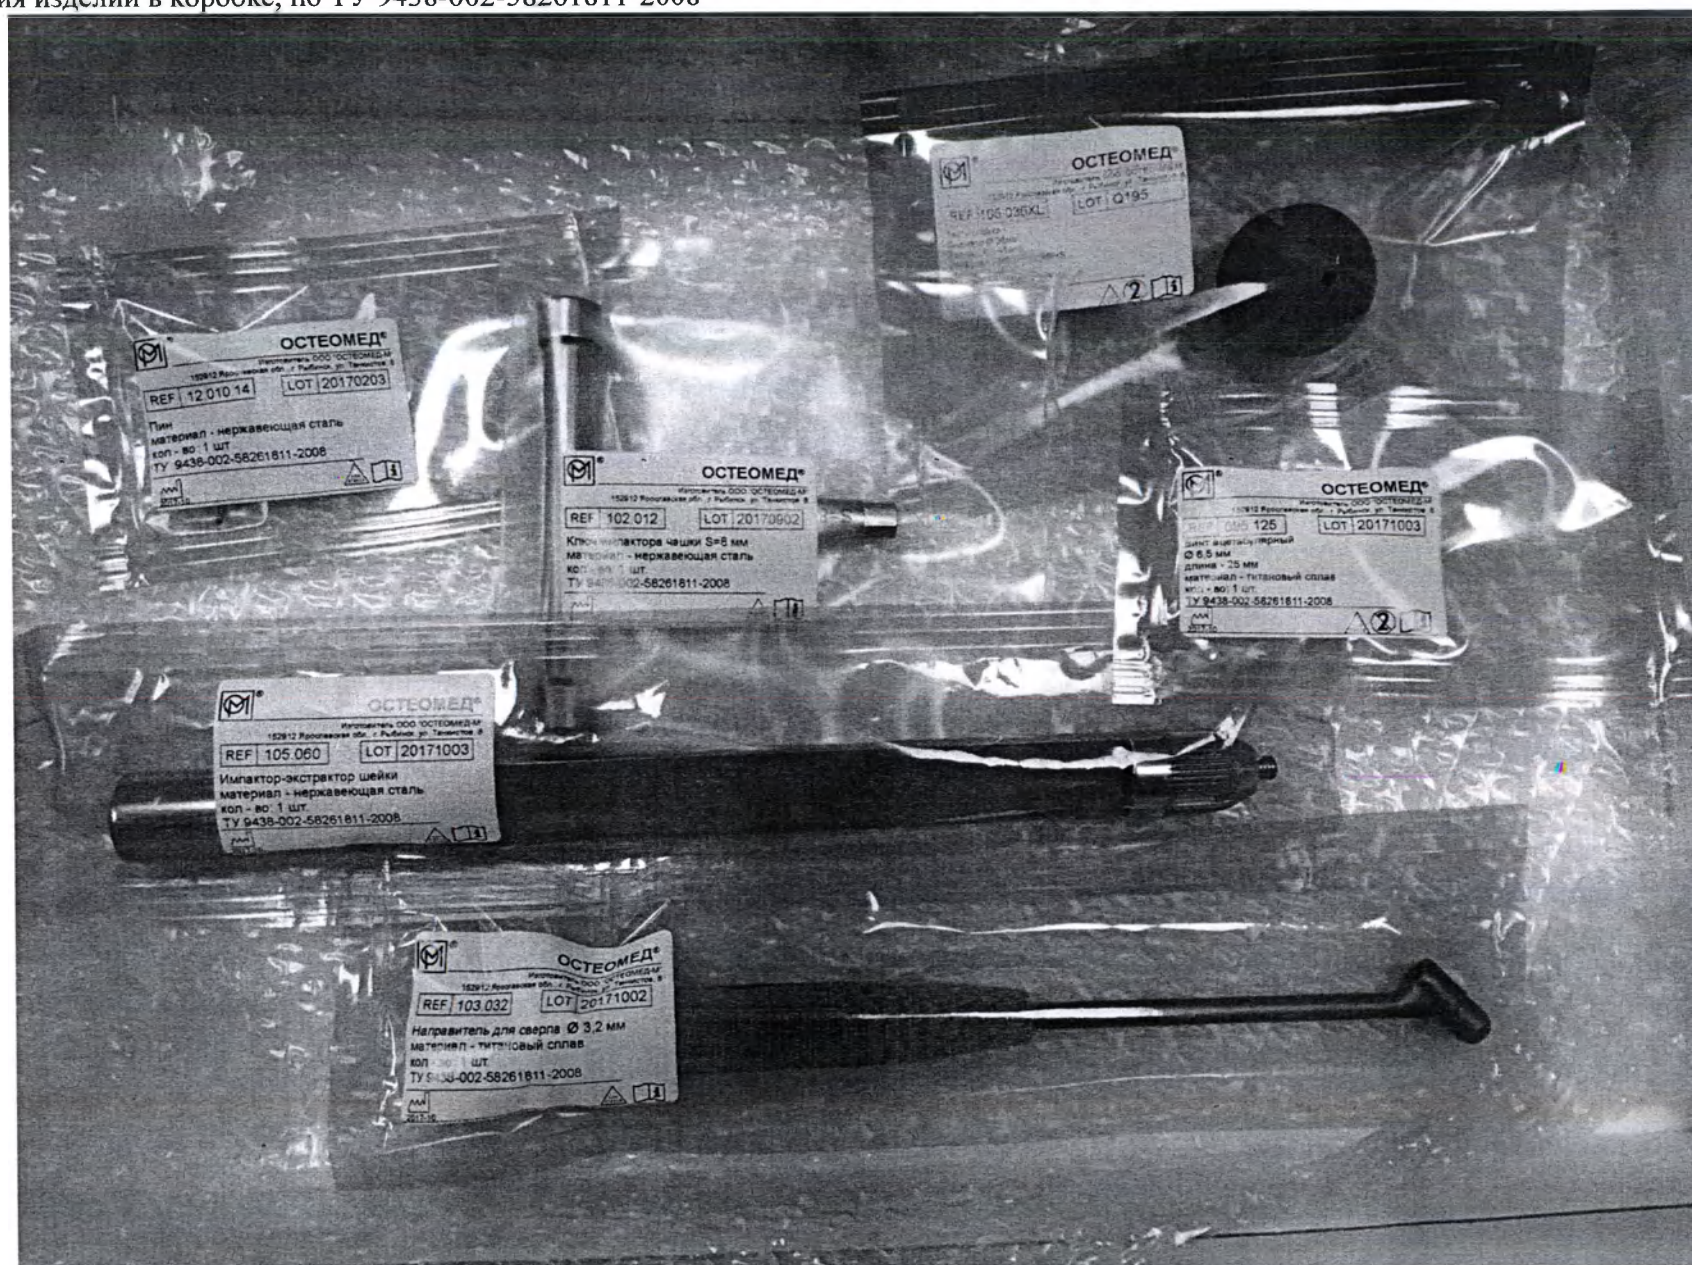




«090.000.00 - Тотальный эндопротез тазобедренного сустава и инструменты для их установки»


Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

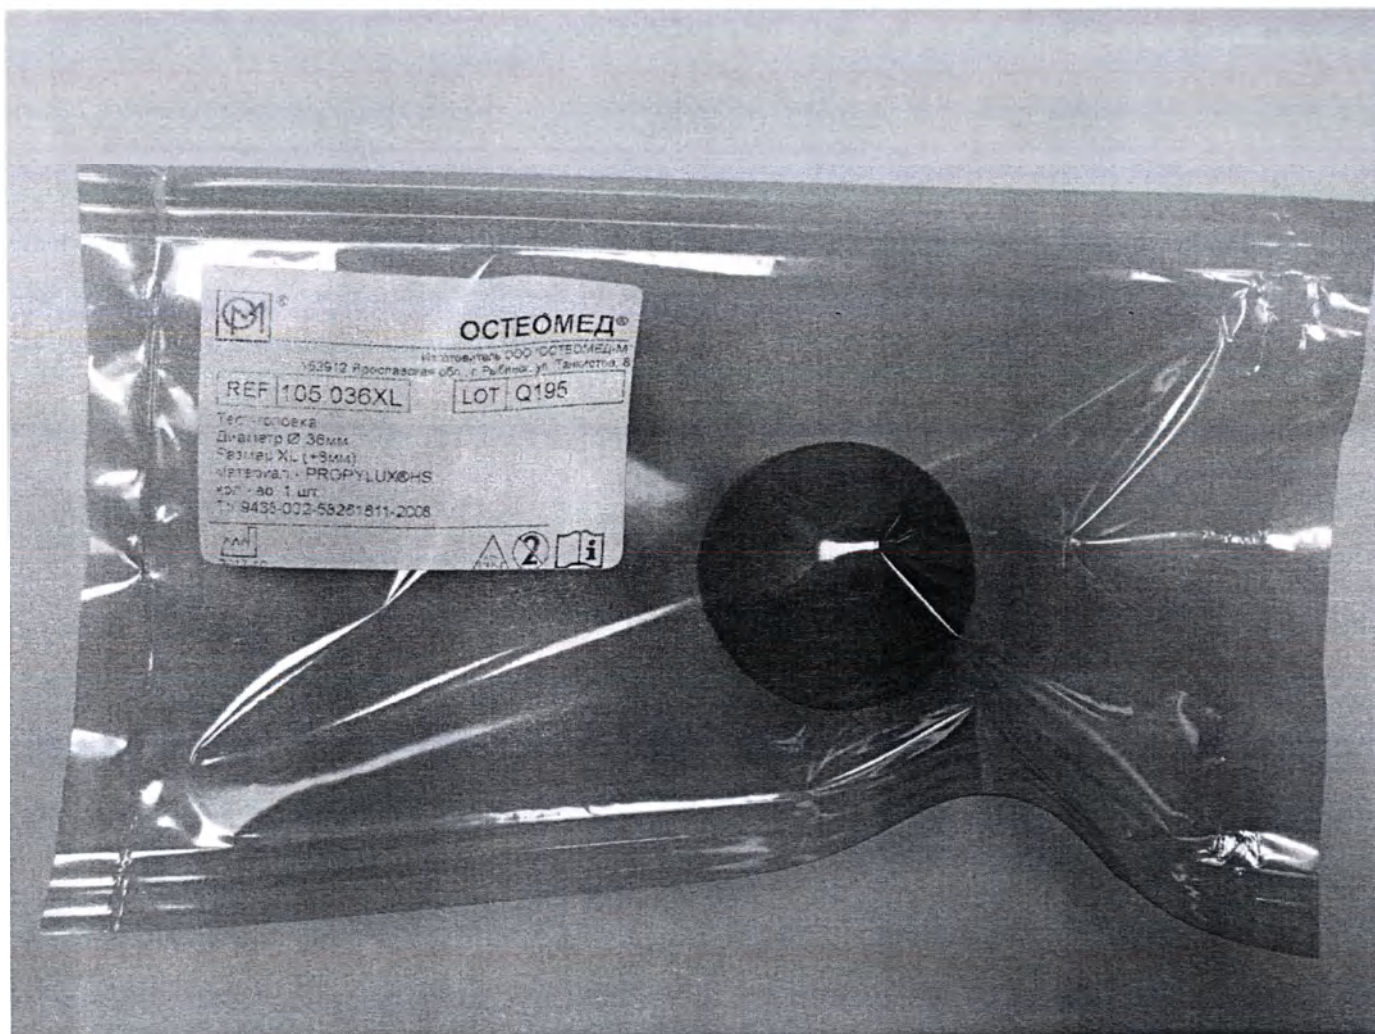


Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

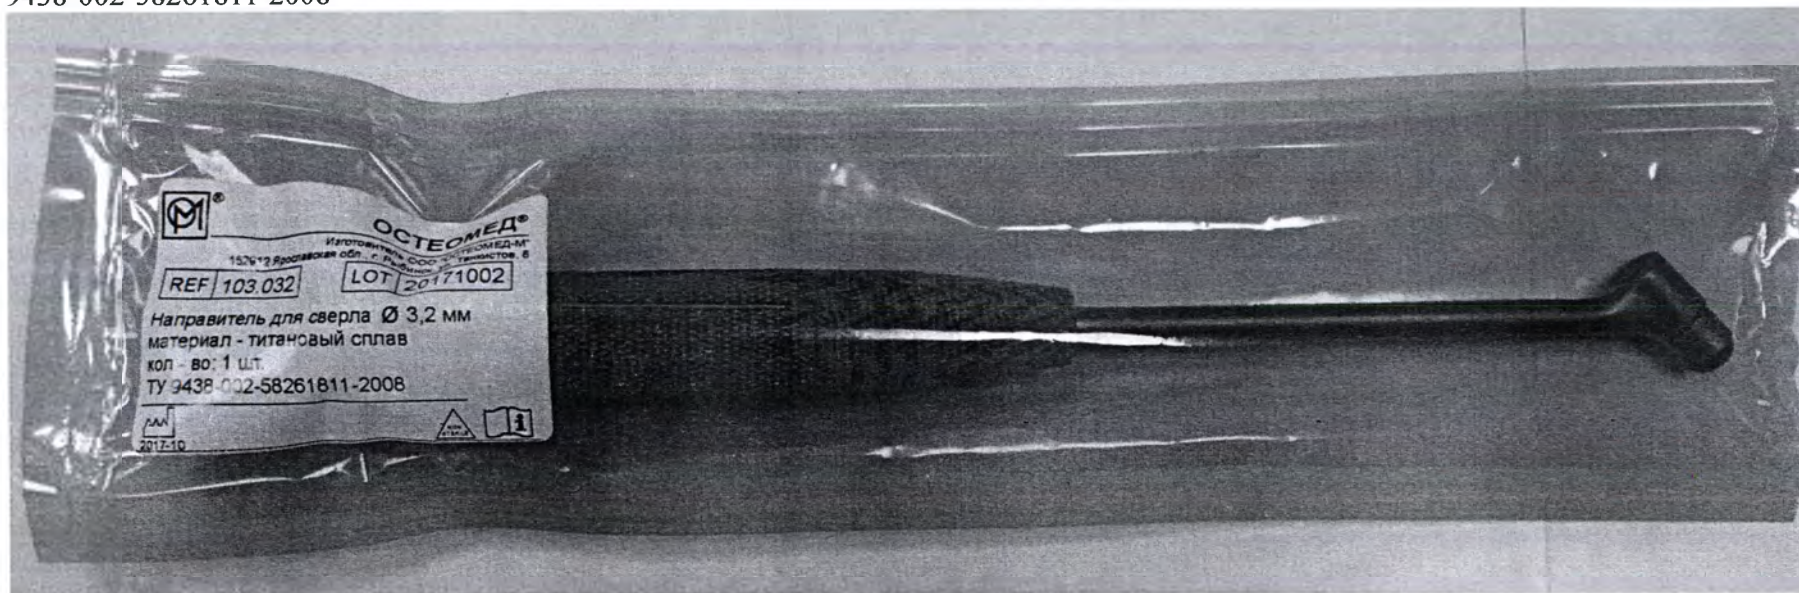


Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

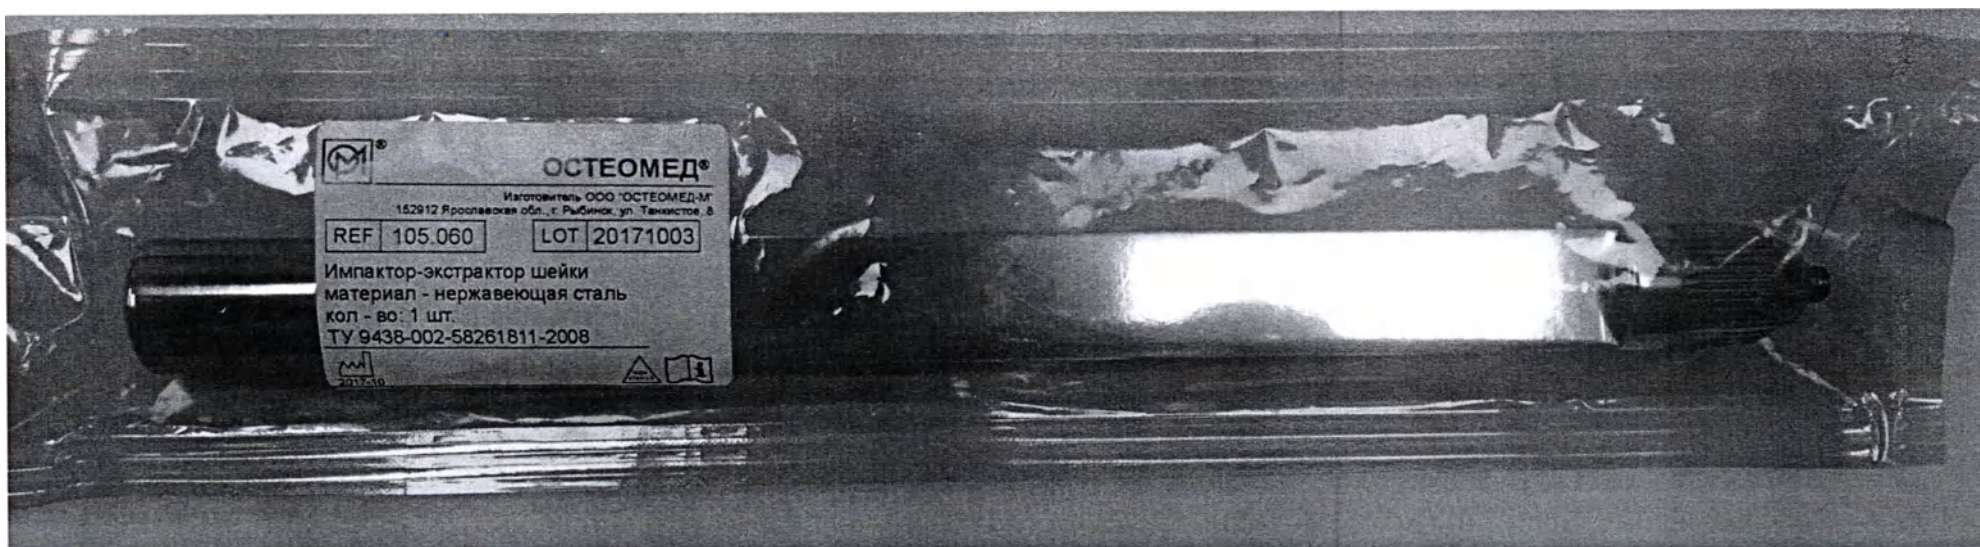


Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

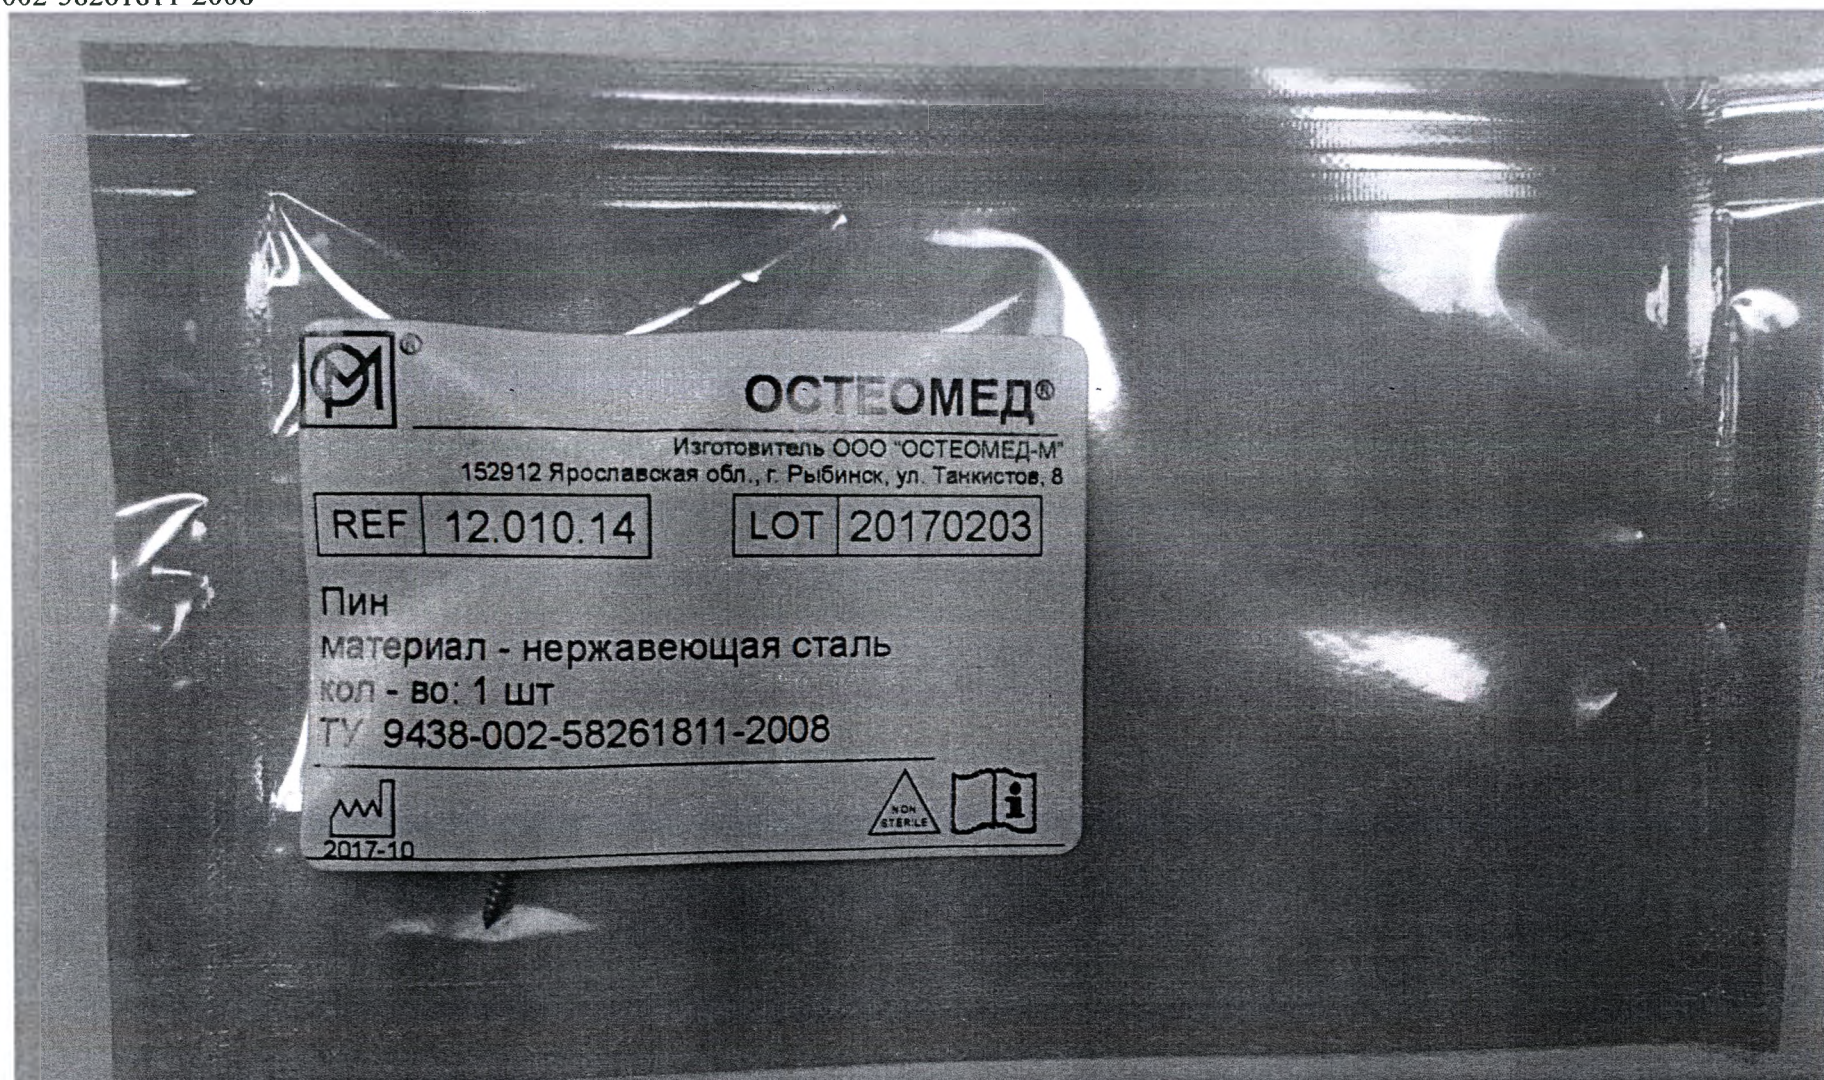


Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008. Маркировка изделия по пункту 1.5.3 ТУ 9438-002-58261811-2008.

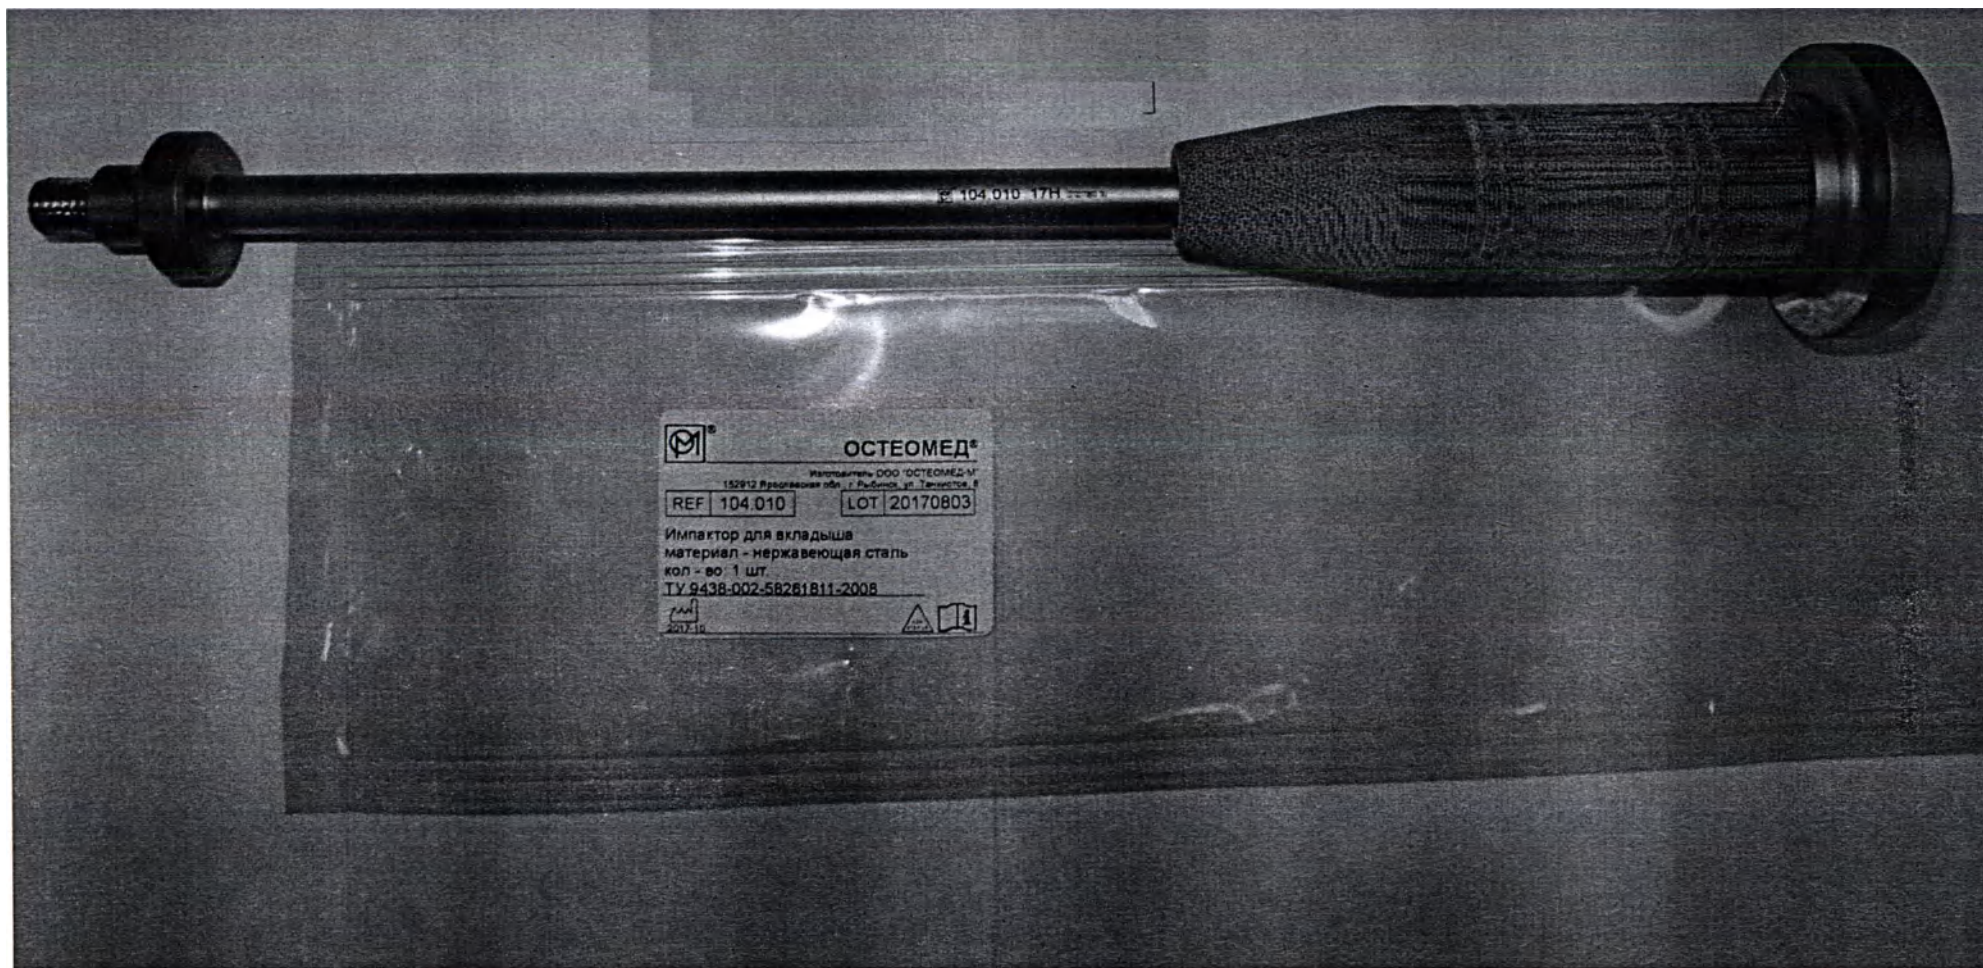


Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008. Маркировка изделия по пункту 1.5.3 ТУ 9438-002-58261811-2008.

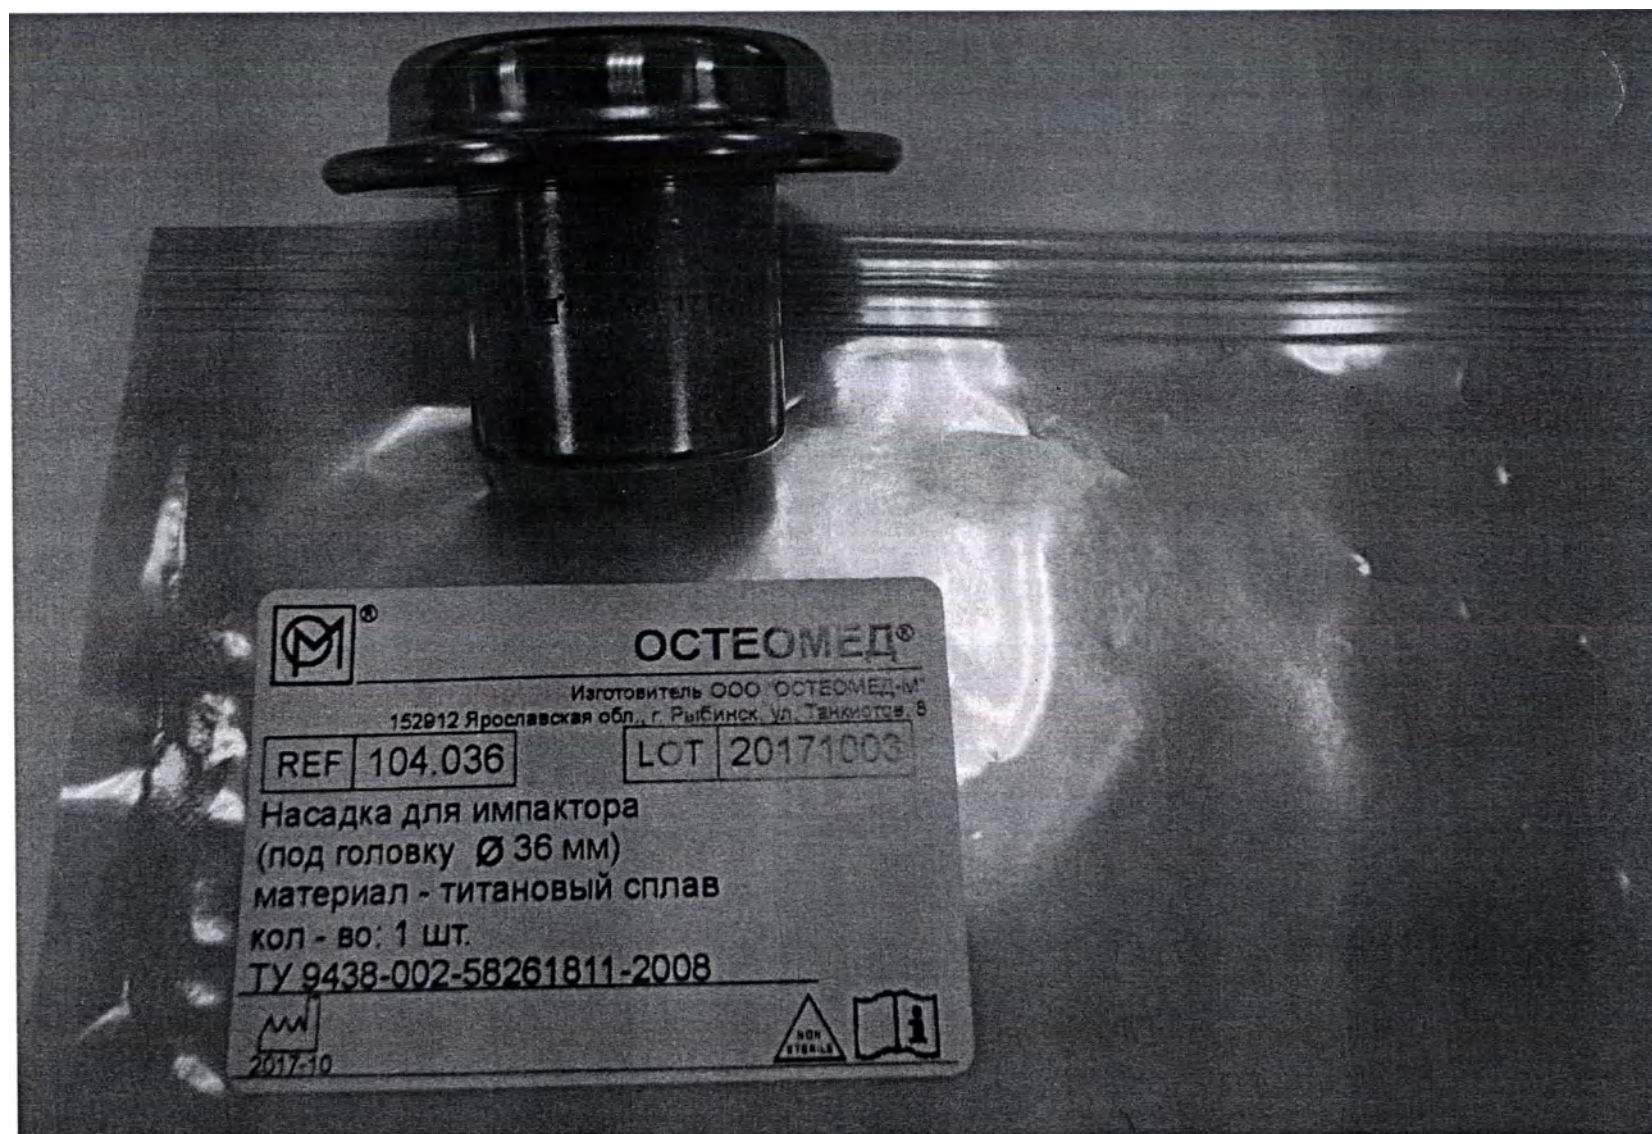

Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

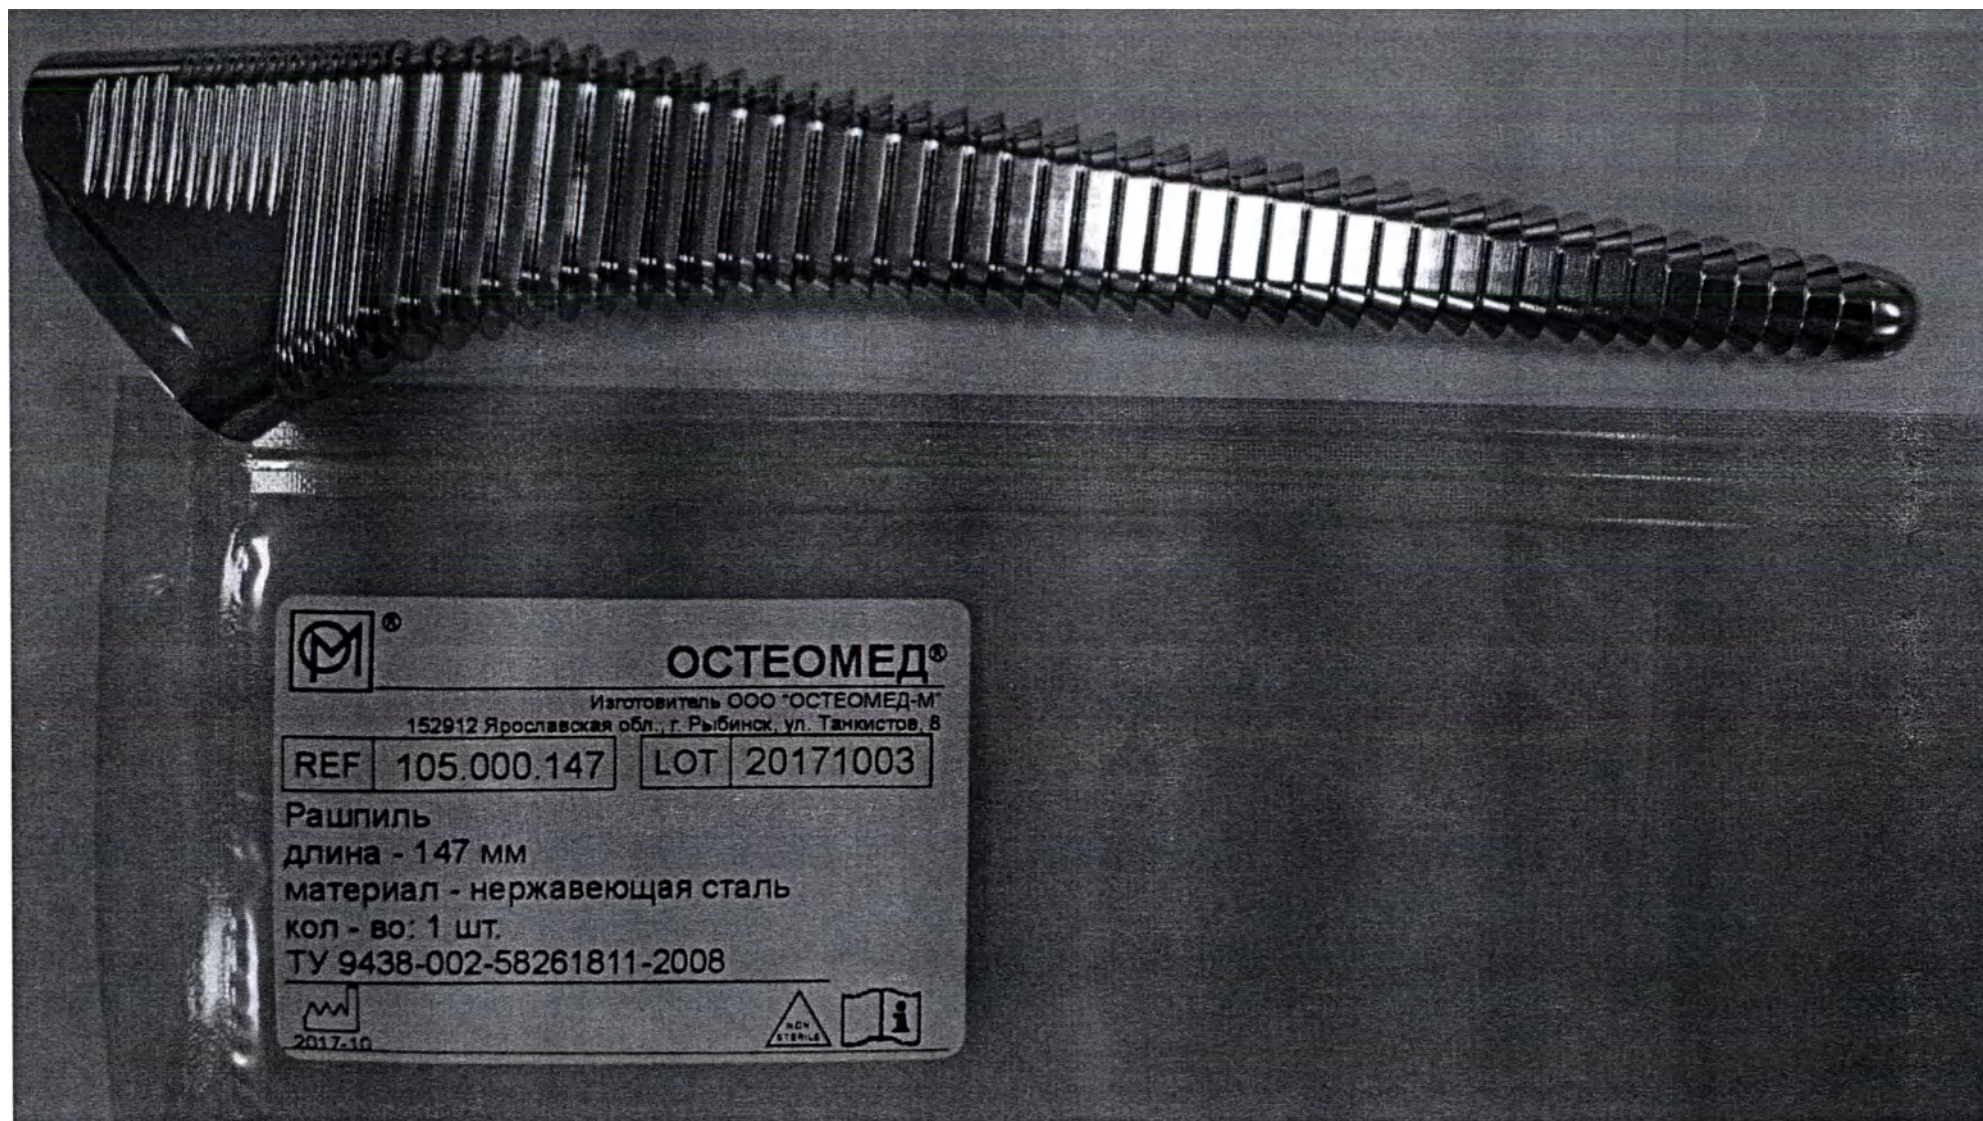


Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

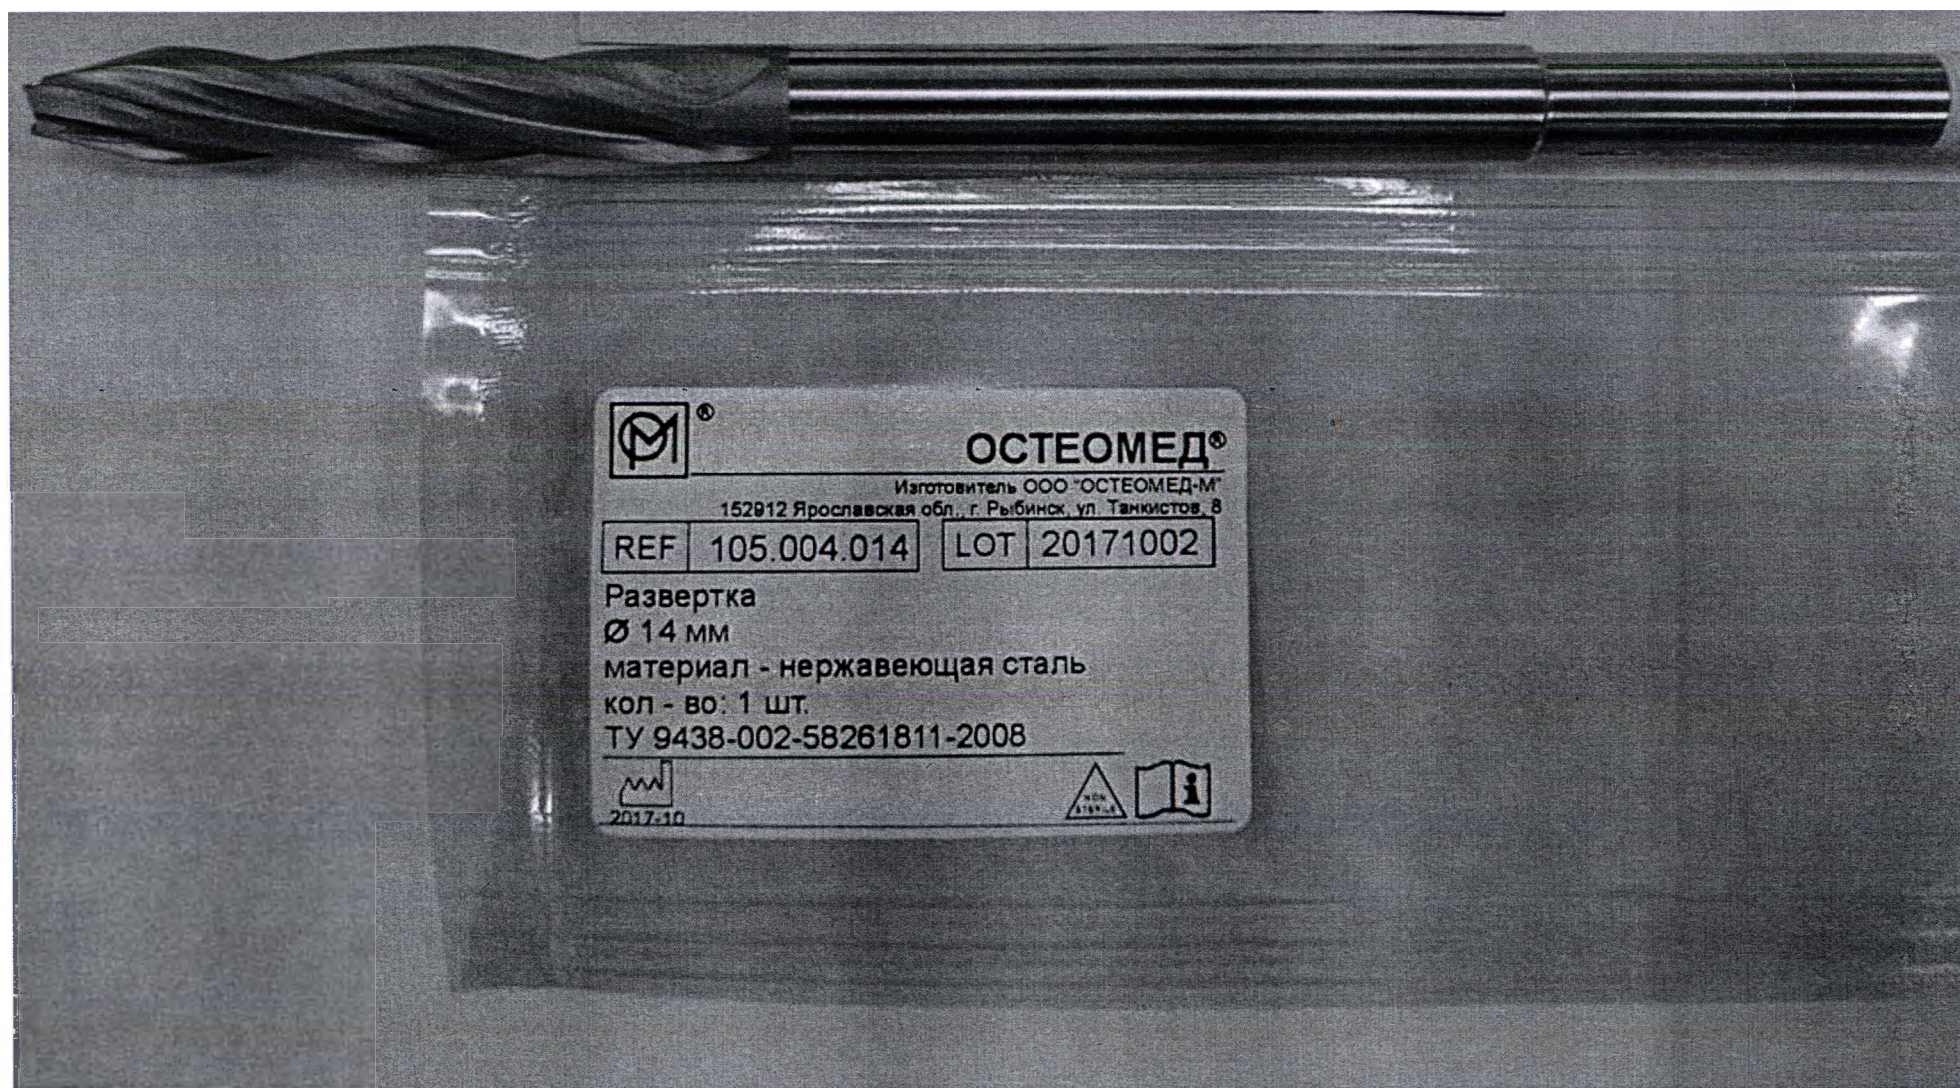


Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008



Фотография изделия в упаковке. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008.

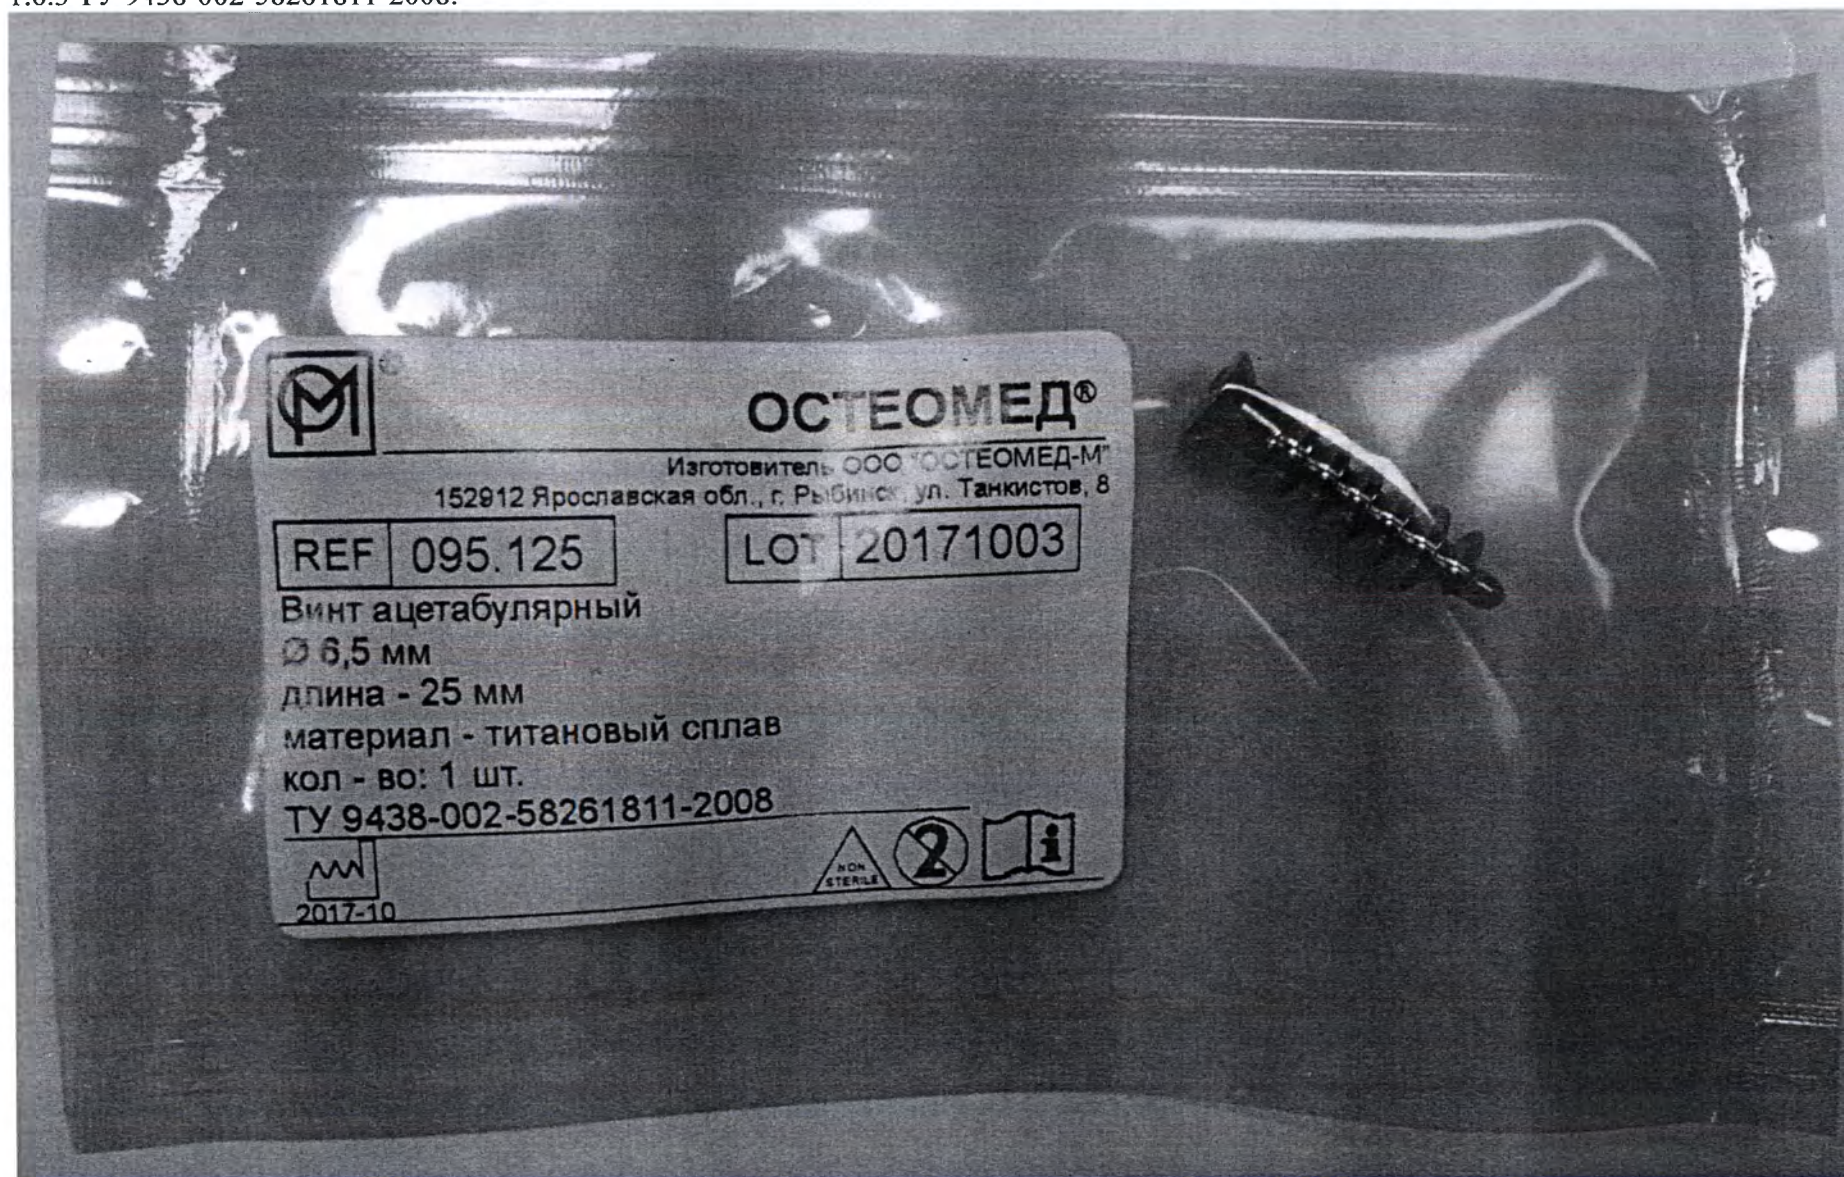


Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008.

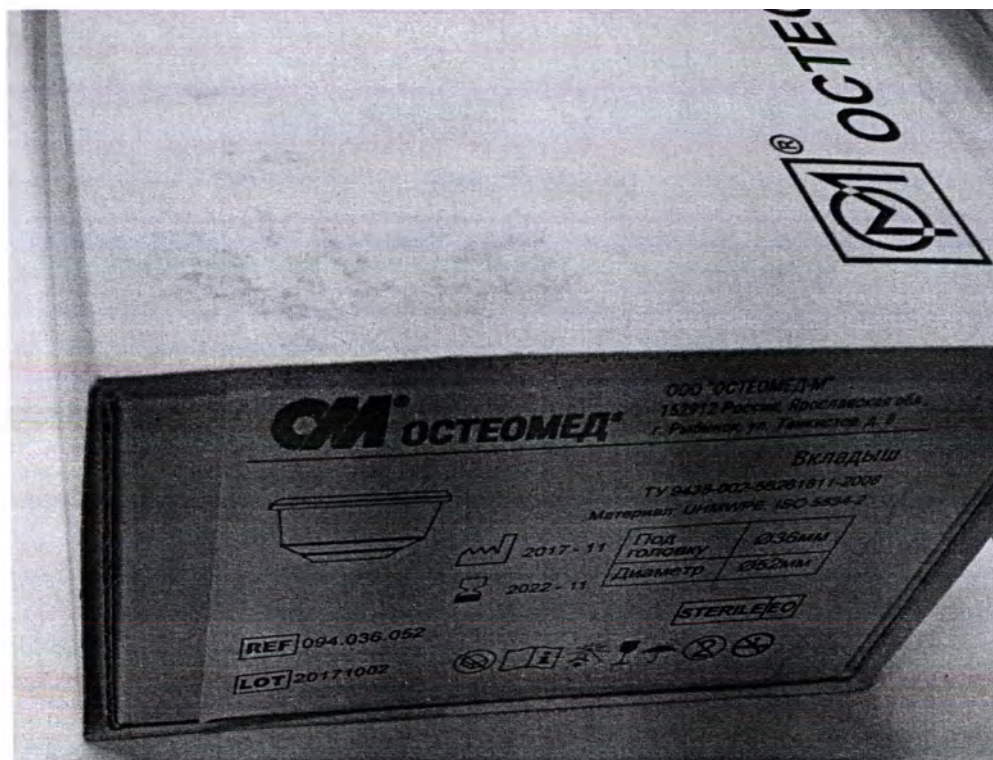

Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008.





Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008.

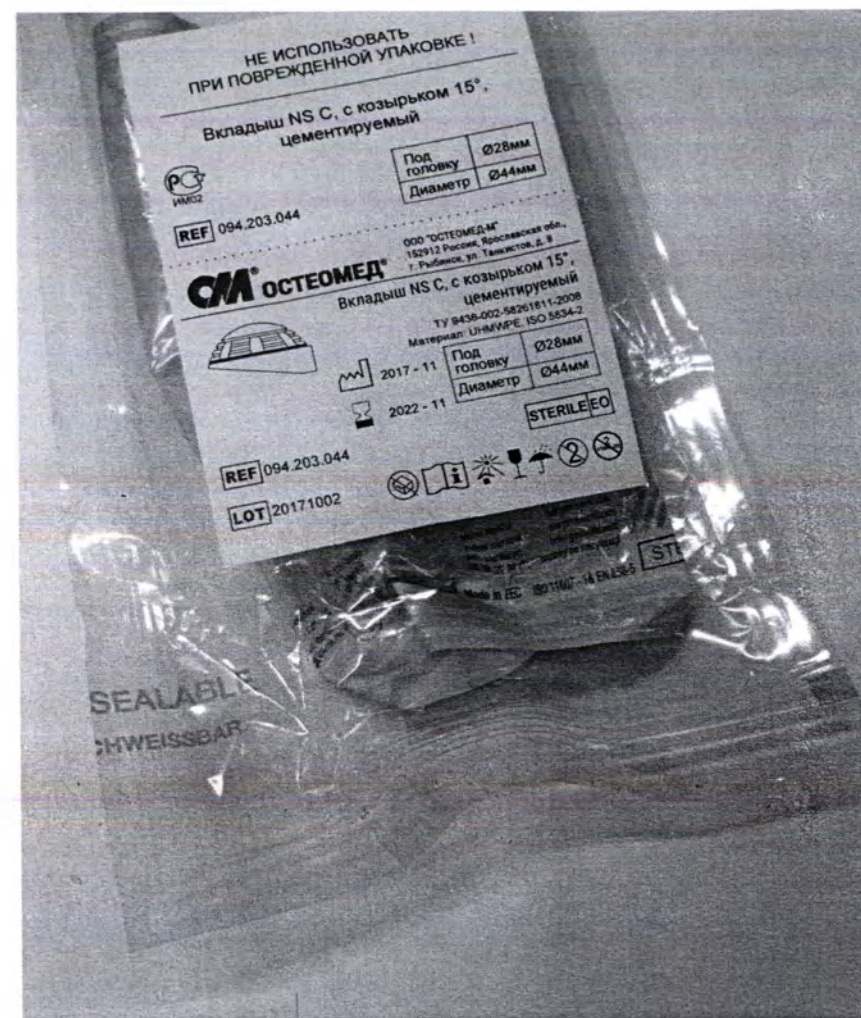



Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008





Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

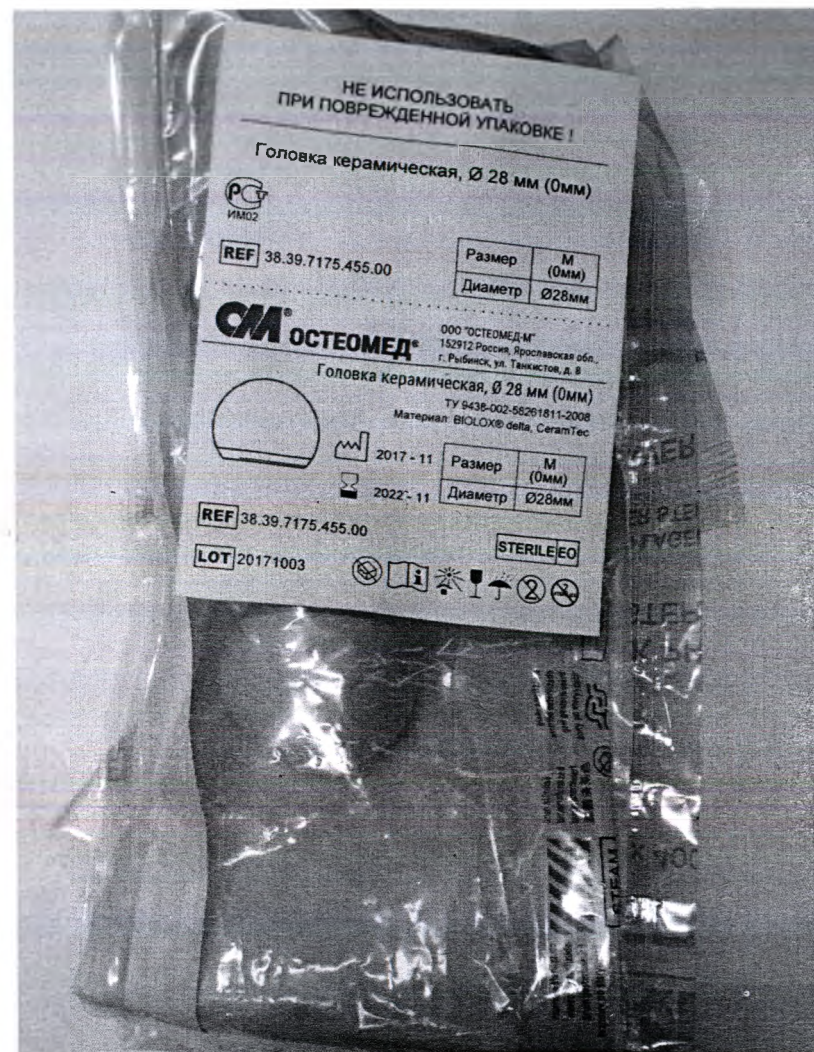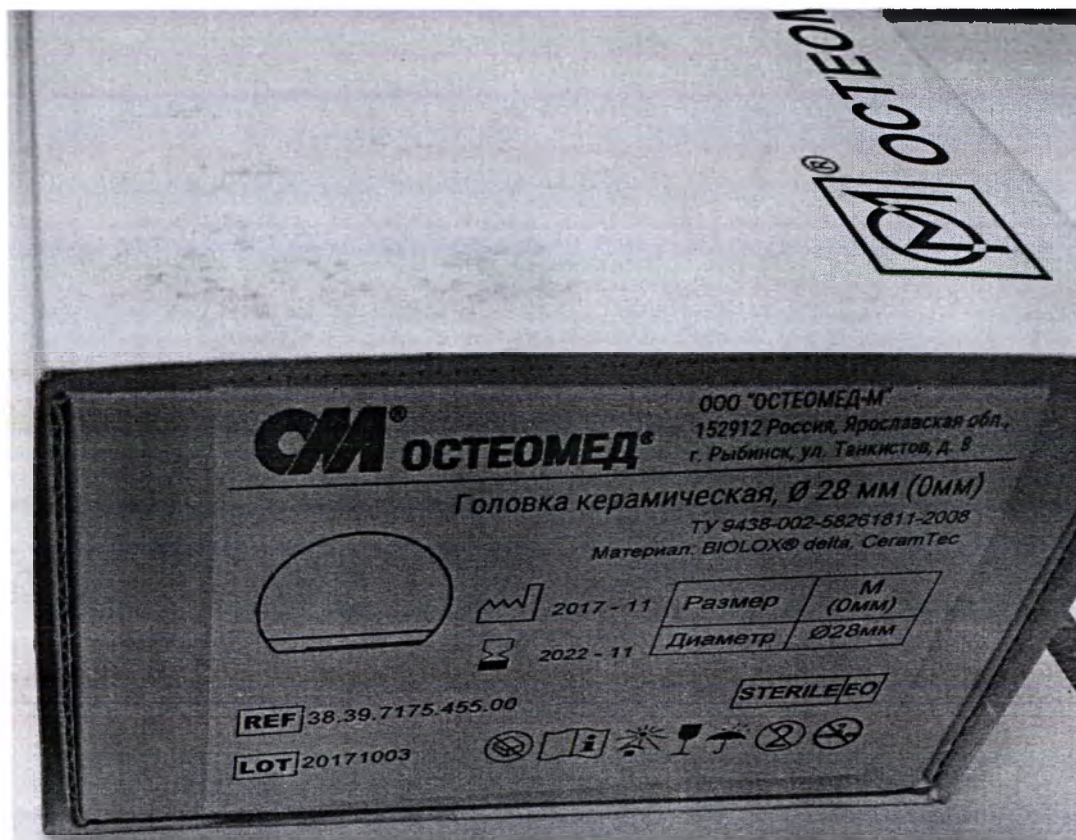



Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

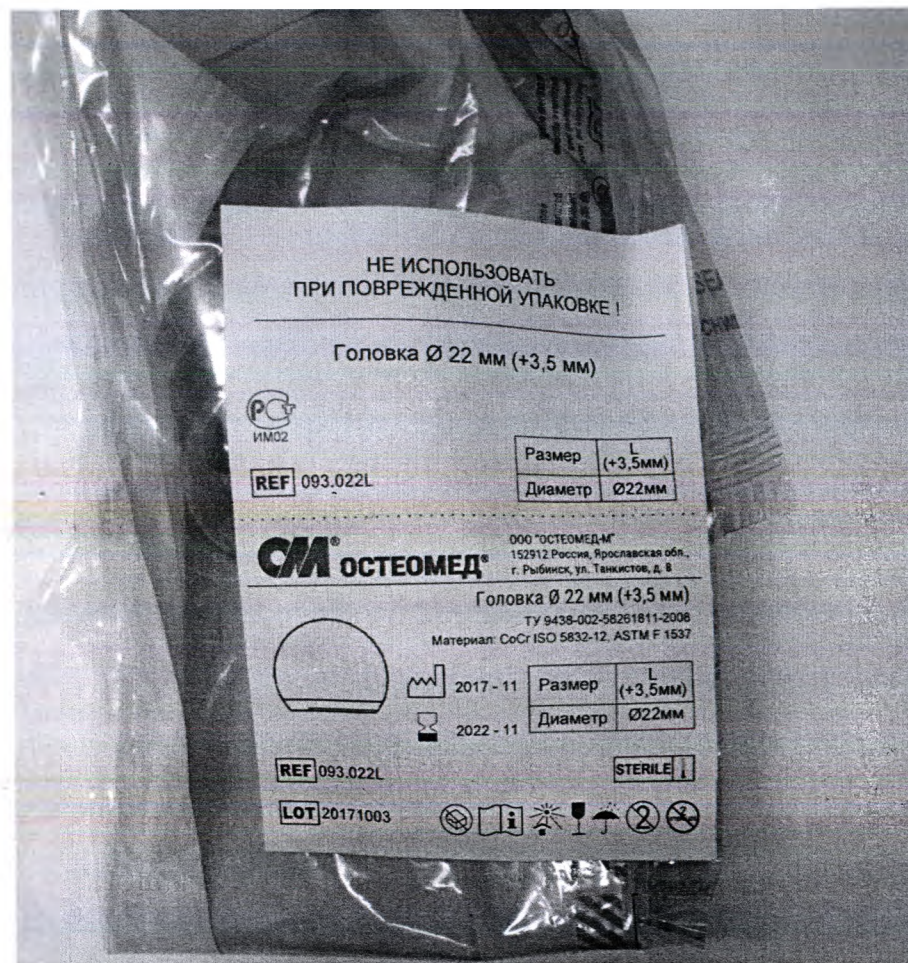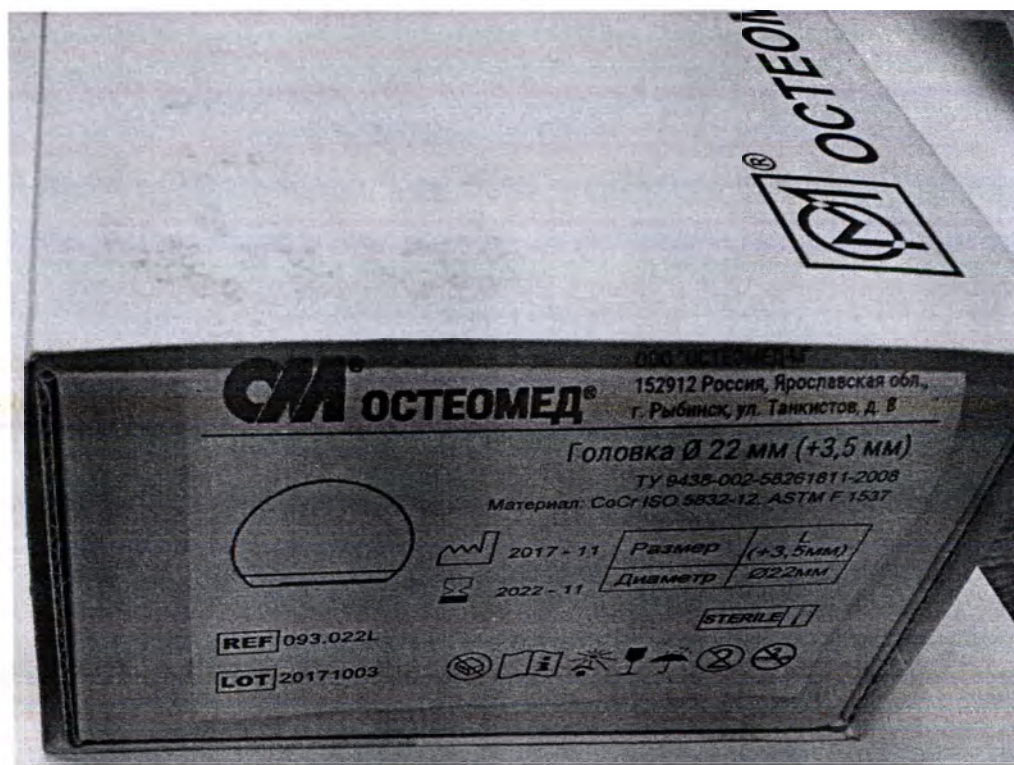



Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

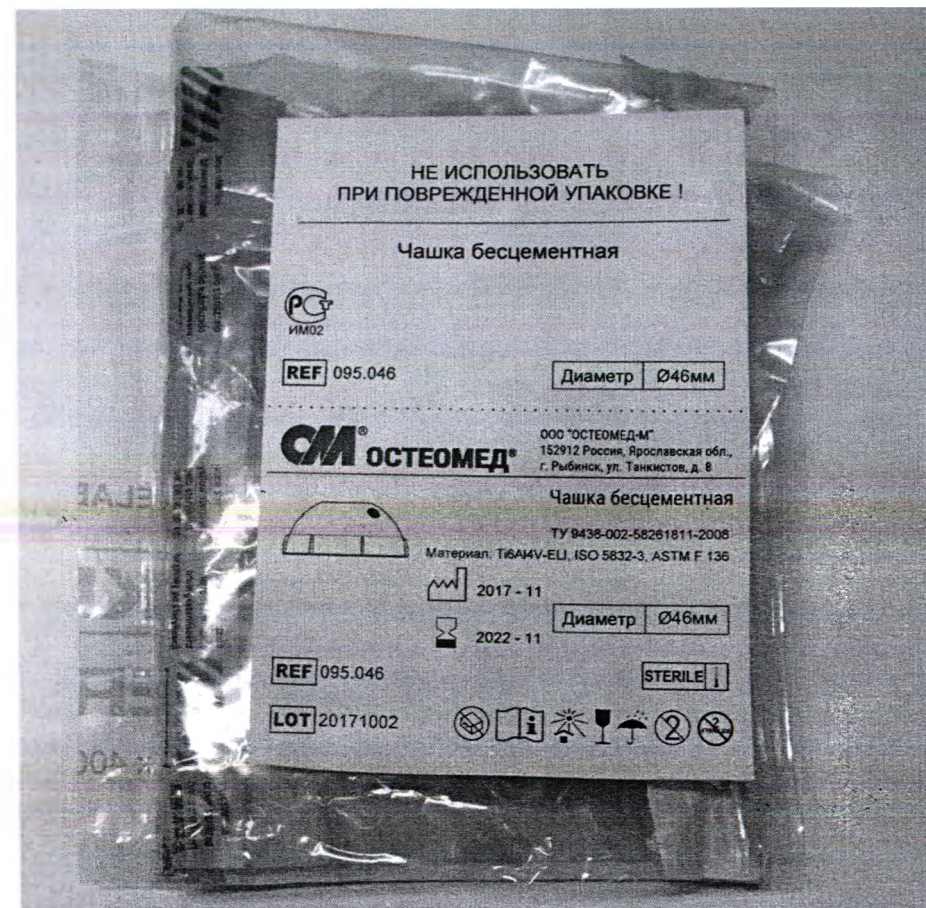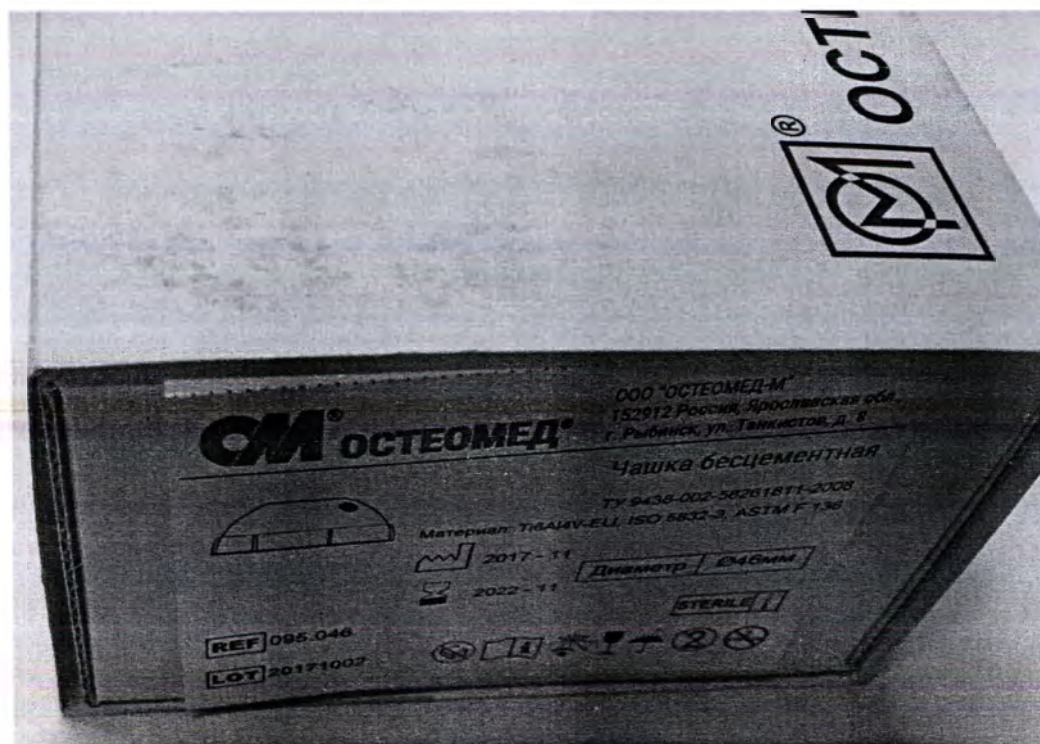


Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

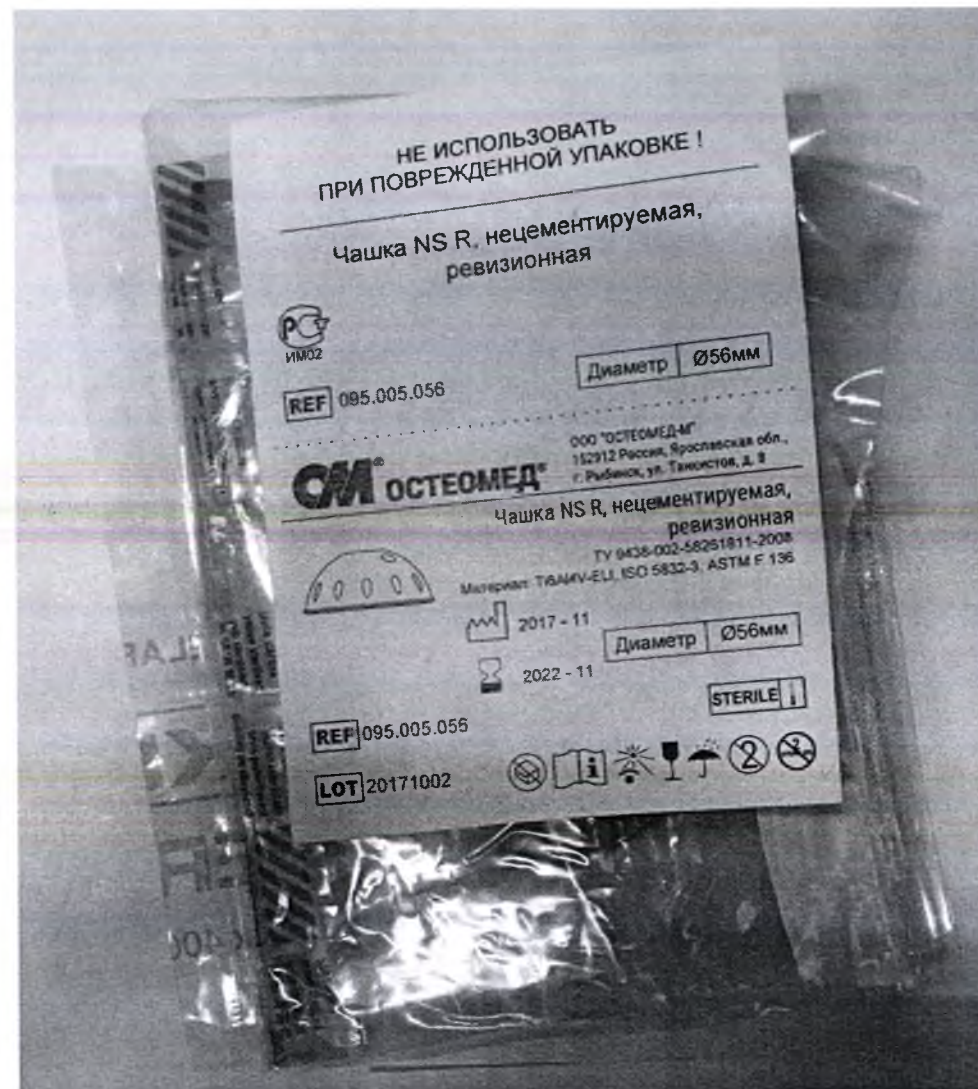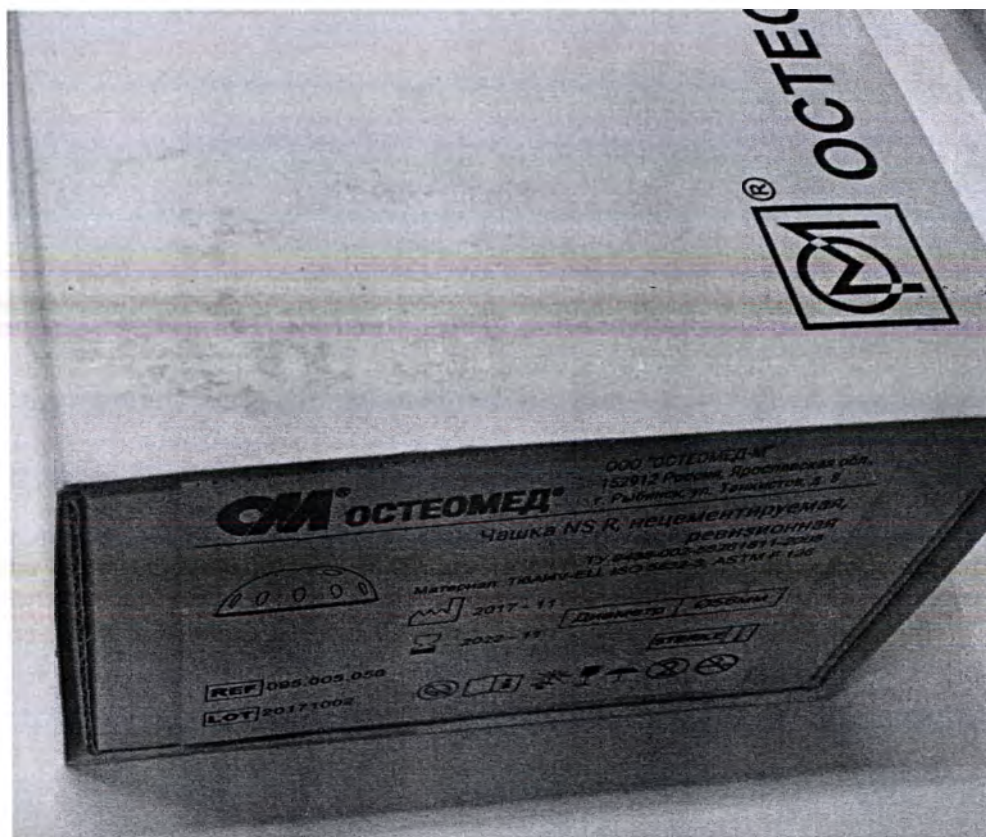


Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

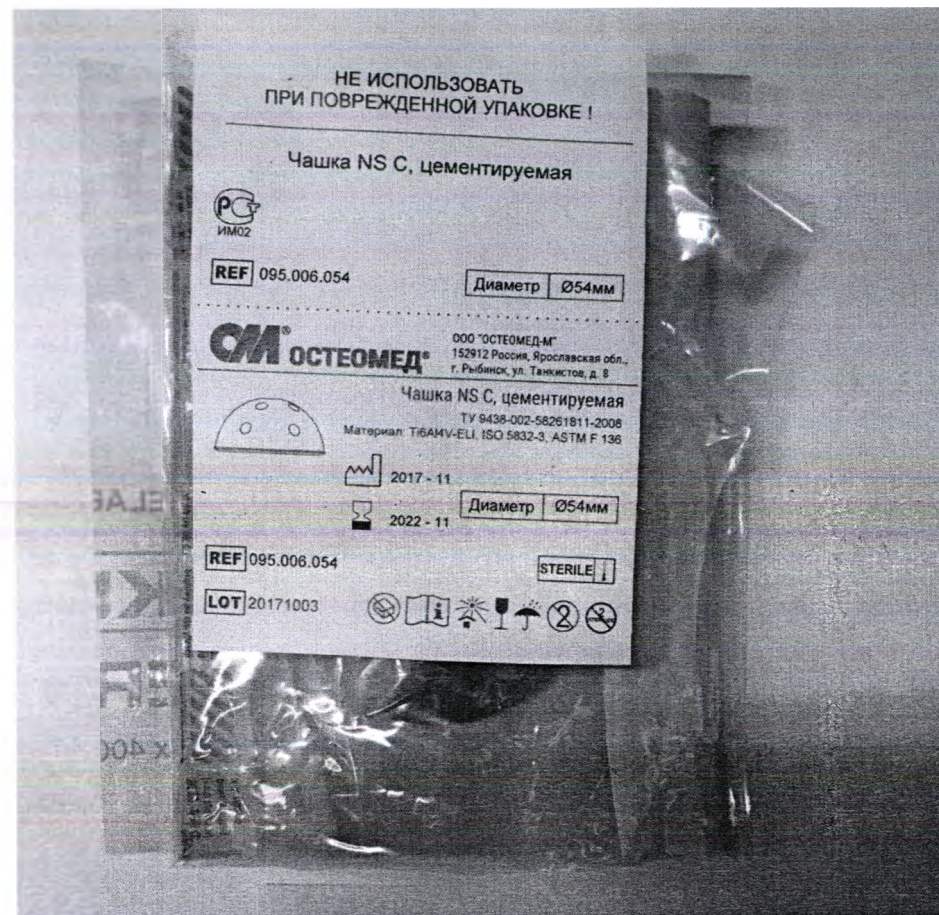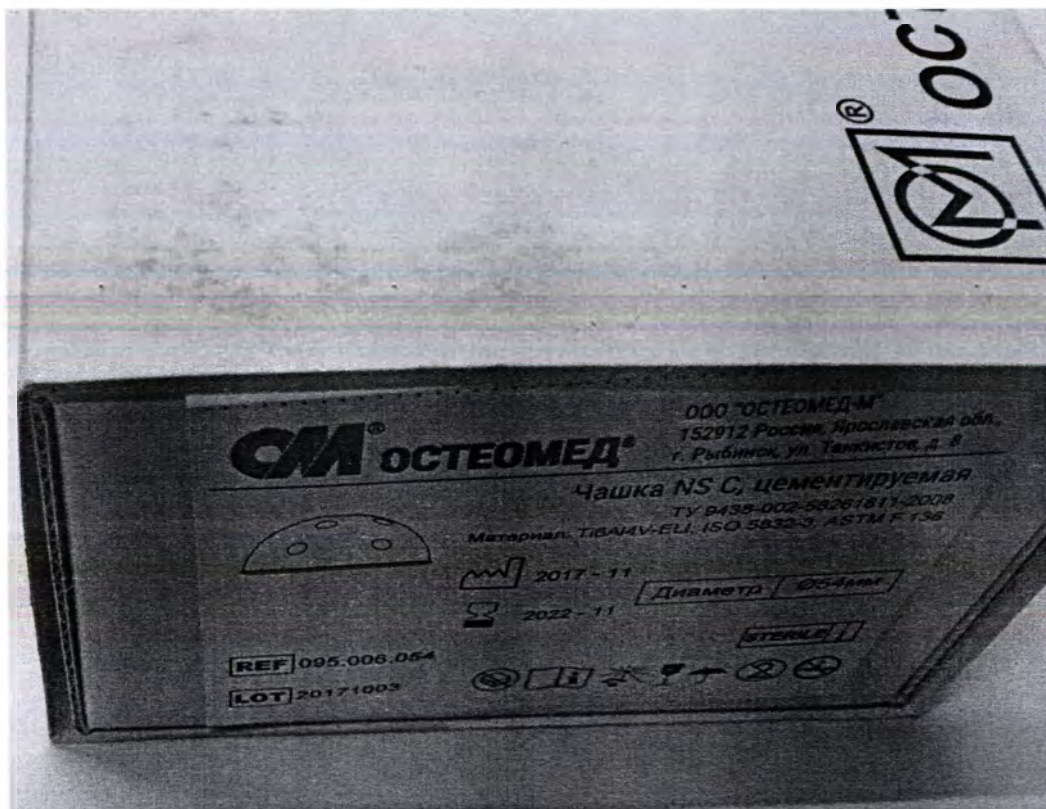



Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

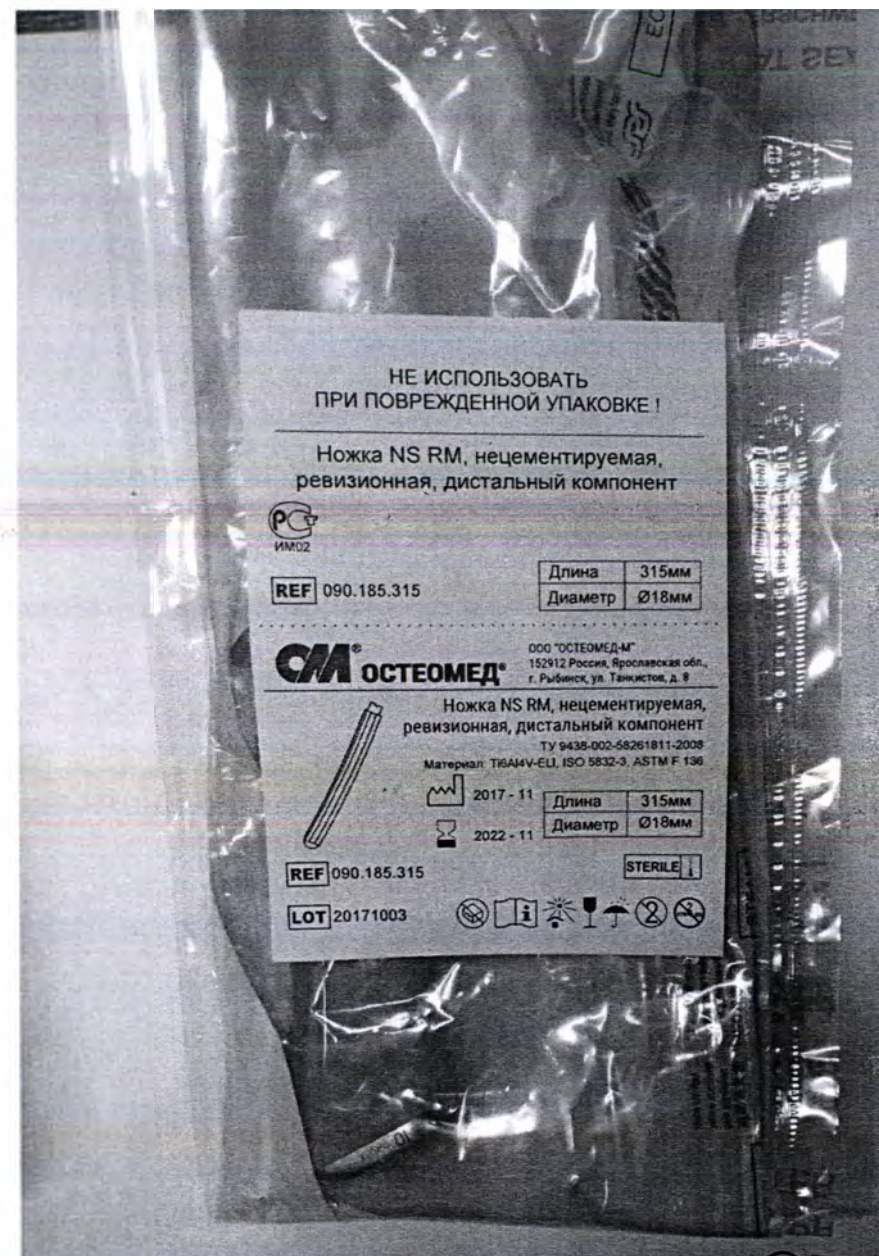


Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

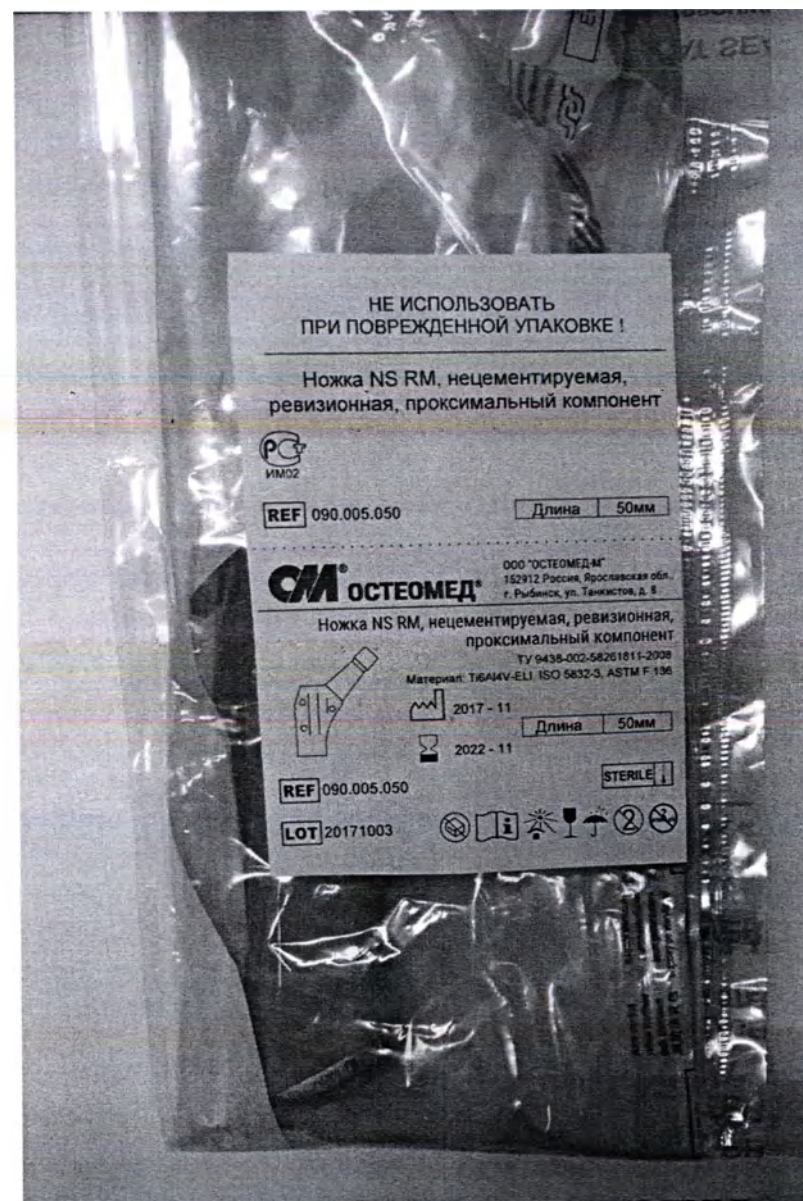



Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

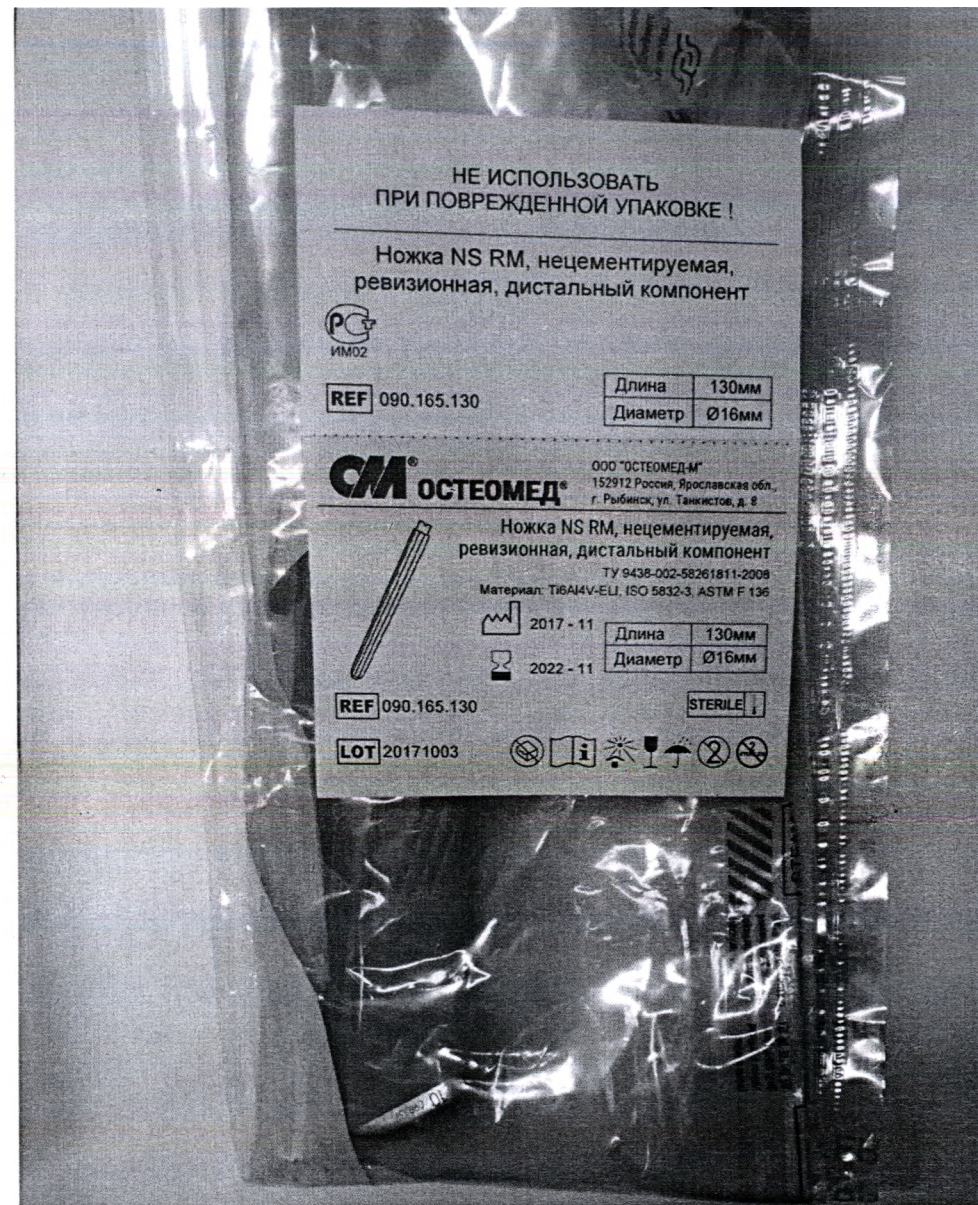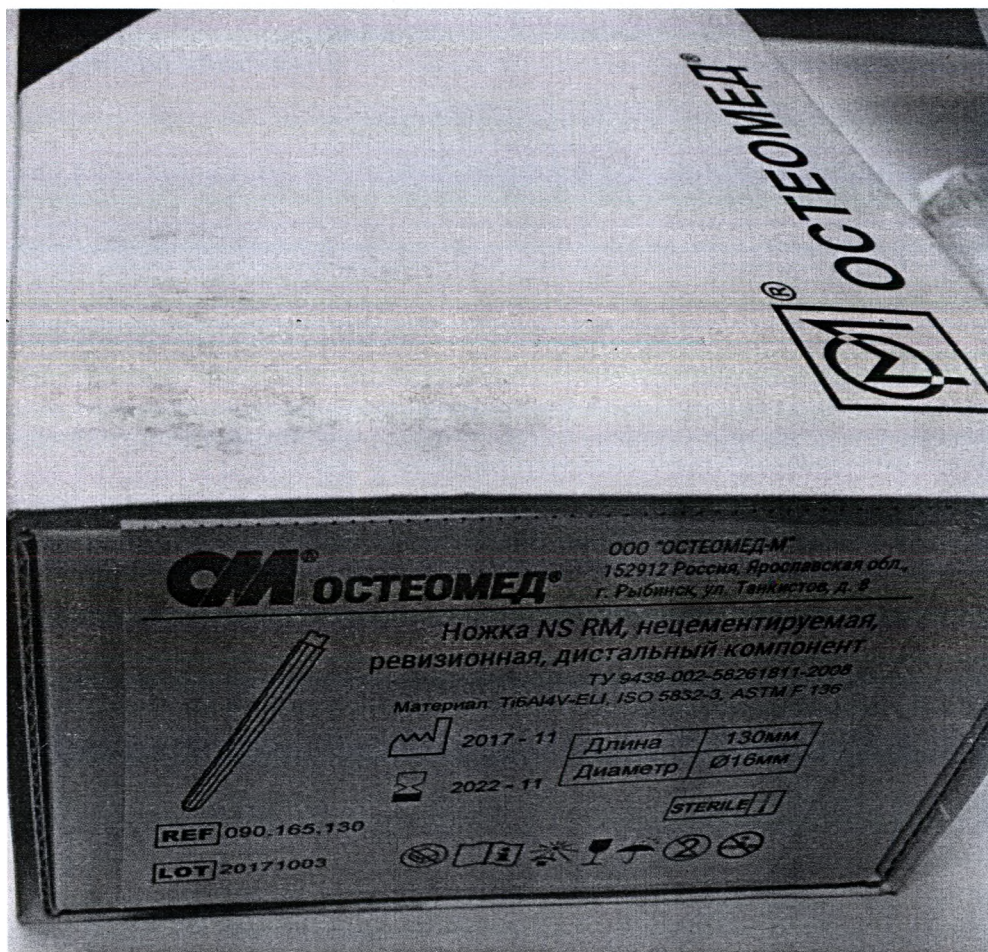


Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

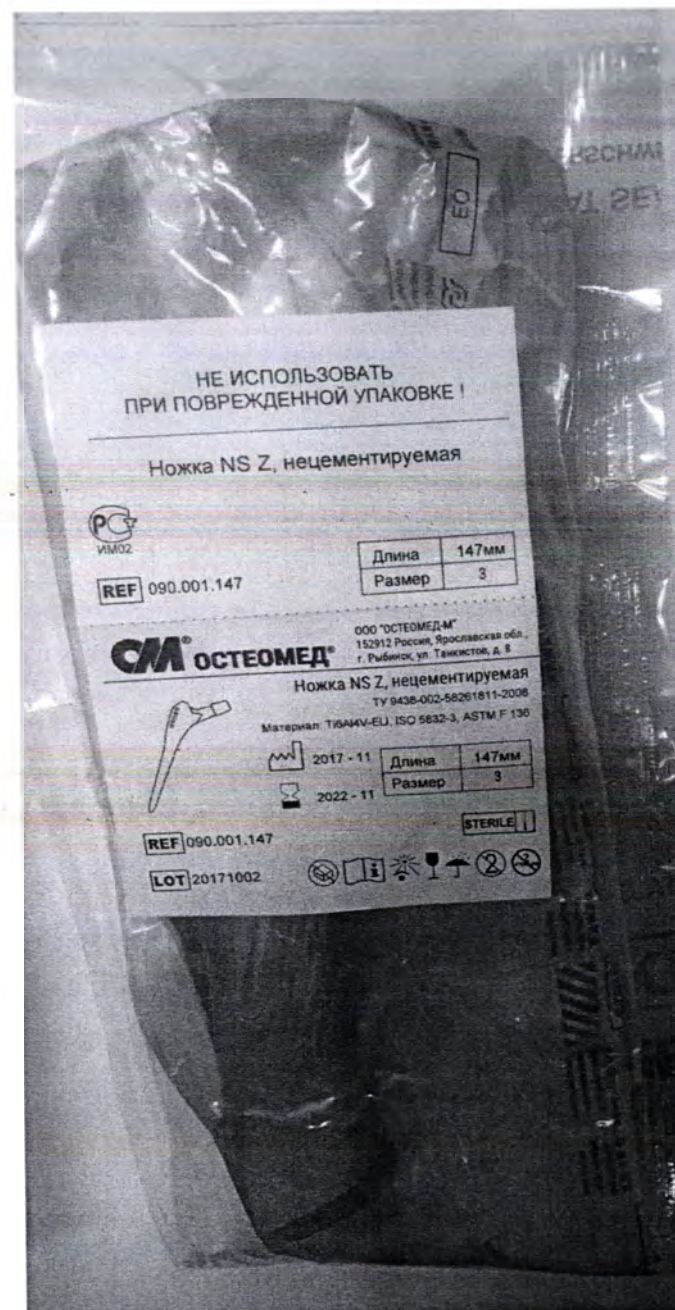


Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

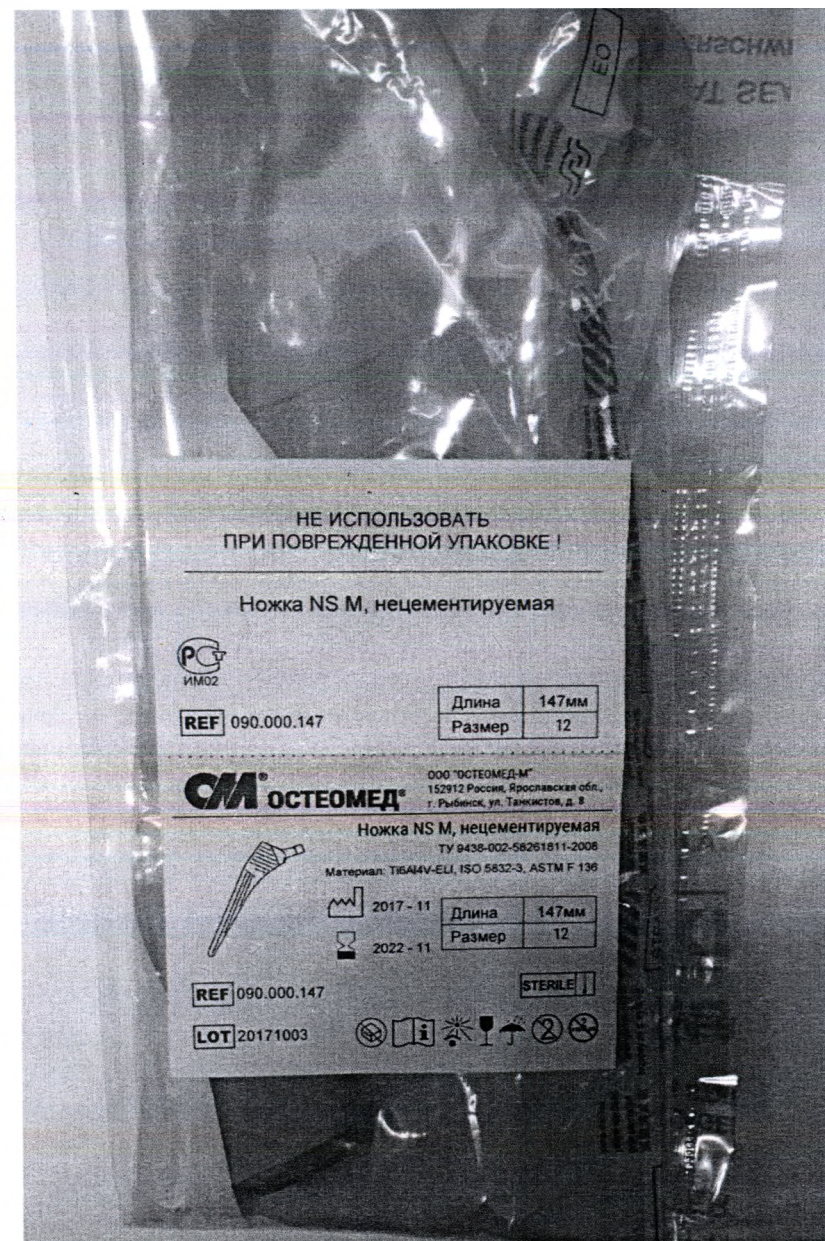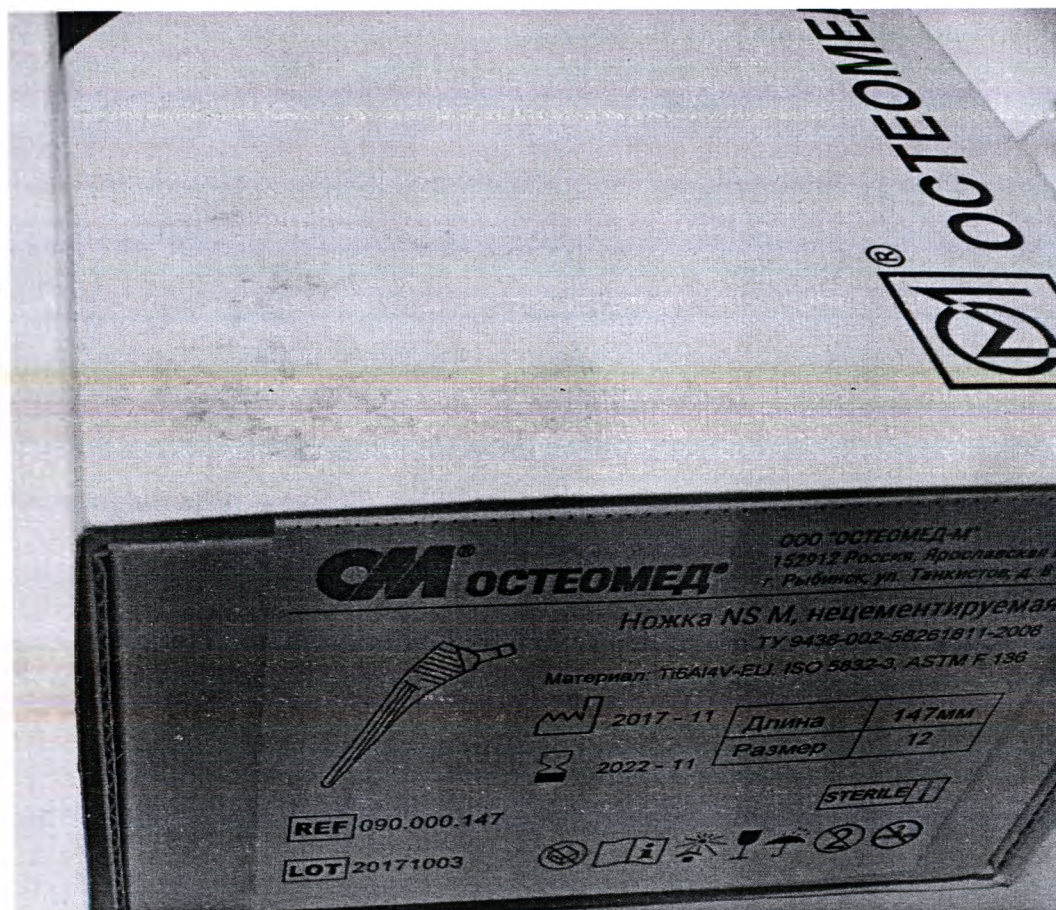

Маркировка этикетки по пунктам 1.5.9, 1.5.11 ТУ 9438-002-58261811-2008.
Изделие упаковано по пункту 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

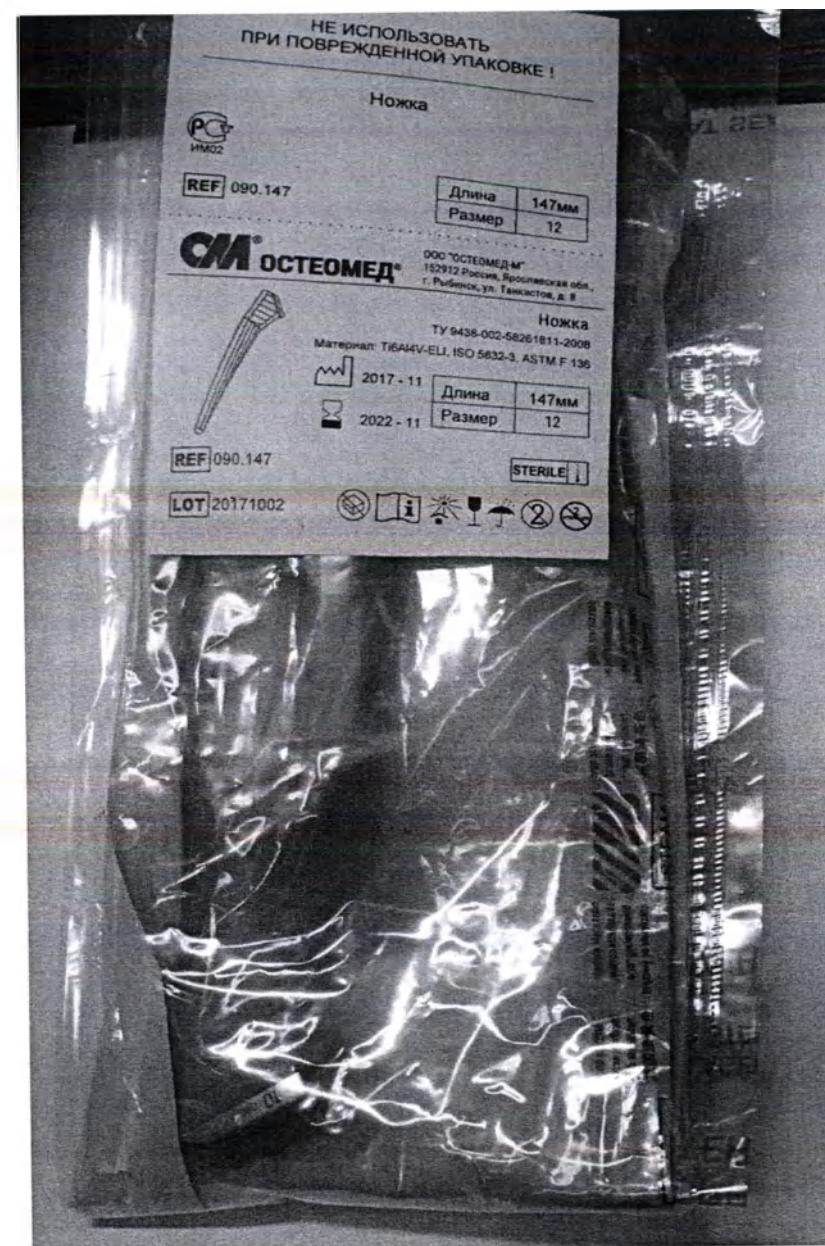


Винты ацетабулярные, длиной 35мм, 45мм, 60мм, 095.135, 095.145, 095.160
Фотография общего вида медицинского изделия разного типоразмерного ряда.

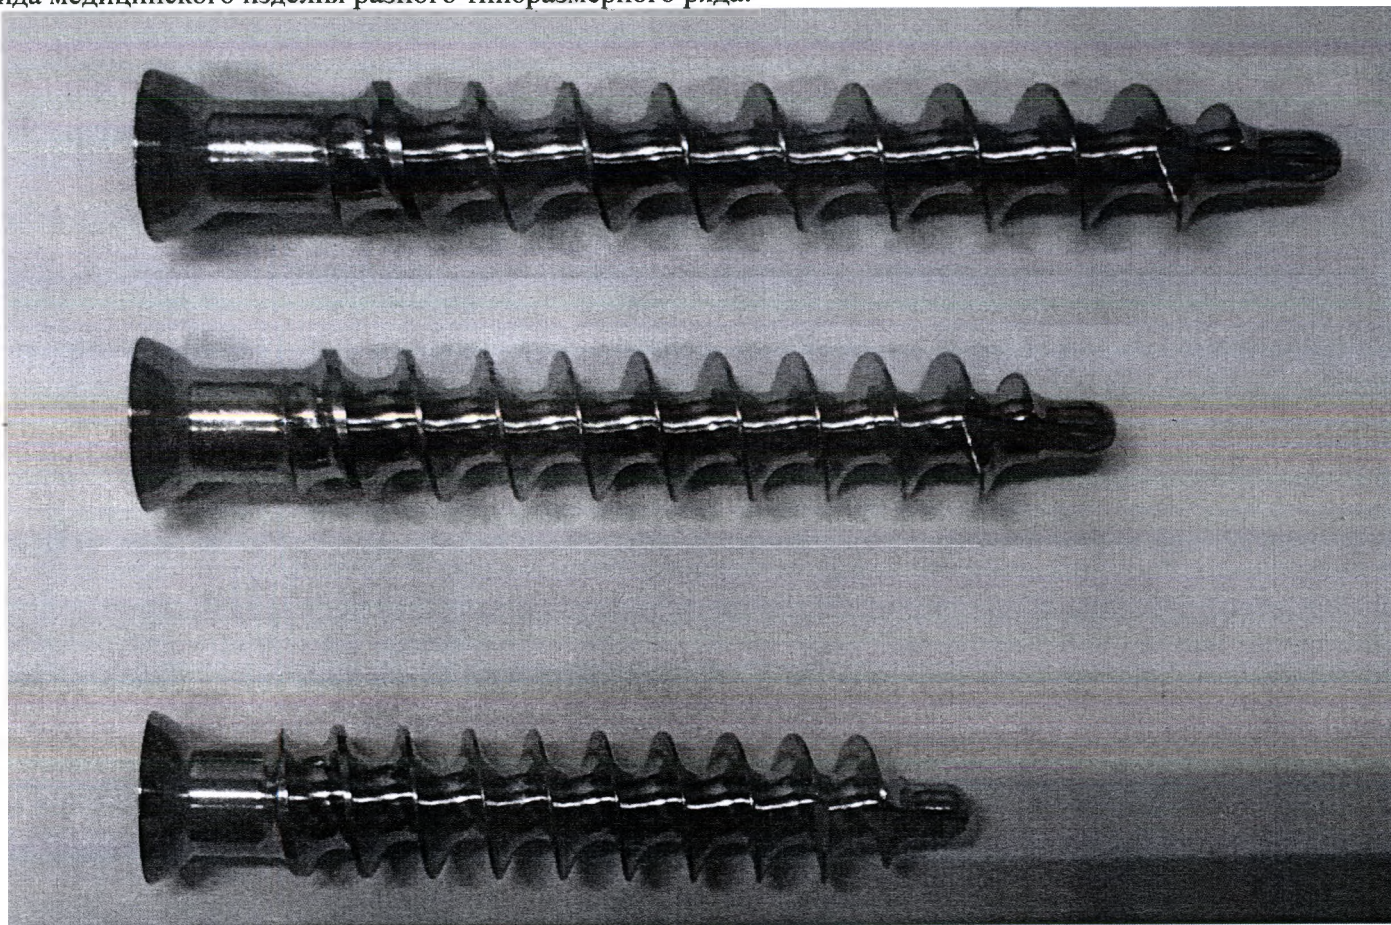

Шейка модульная. Прямая, короткая, высота 30мм, 092.030.REC

Шейка модульная. Прямая, длинная, высота 40,5мм, 092.040.REC

Фотография общего вида медицинского изделия разного типоразмерного ряда.

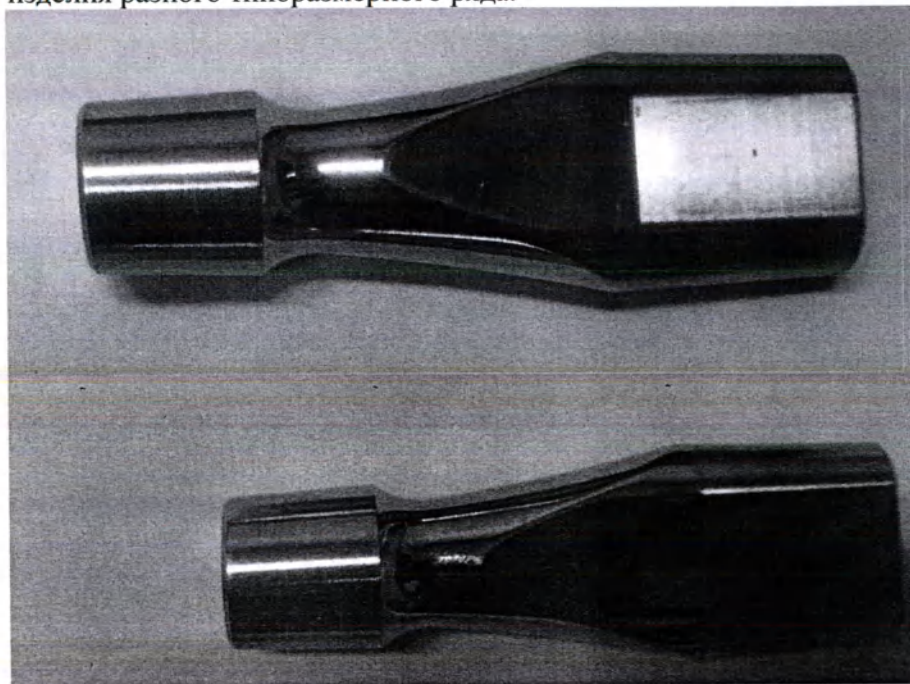

Головка Ø44мм. Глубина посадки: -4мм, 0, +4мм, 093.044S, 093.044M, 093.044L.

Фотография общего вида медицинского изделия разного типоразмерного ряда.




Ножка. Размер/длина: 11/142, 090.142

Ножка NS С, цементируемая. Размер/Длина: 12,50/147,00мм, 090.003.012


Ножка NS W, нецементируемая, ревизионная. Диаметр/Длина: 14/225мм, 090.144.255

Внешний вид изделий

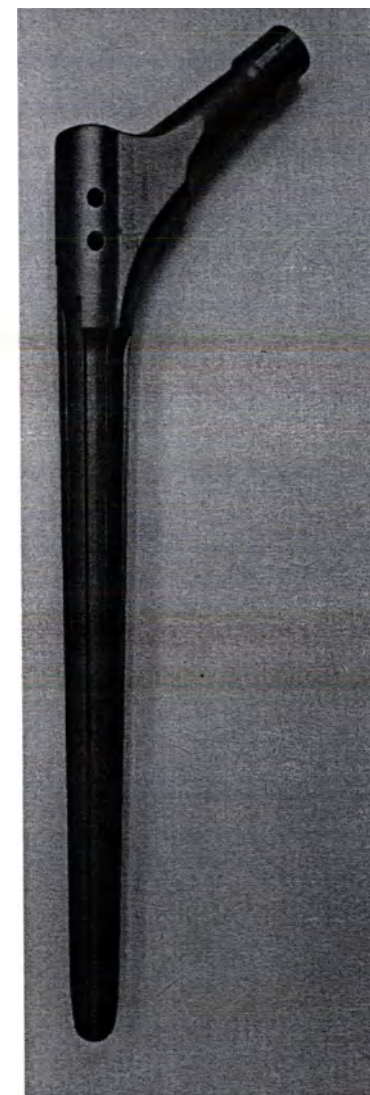


Ножка. Размер/длина: 10/137, 11/142, 12/147, 090.137, 090.142, 090.147.

Фотография общего вида медицинского изделия разного типоразмерного ряда.

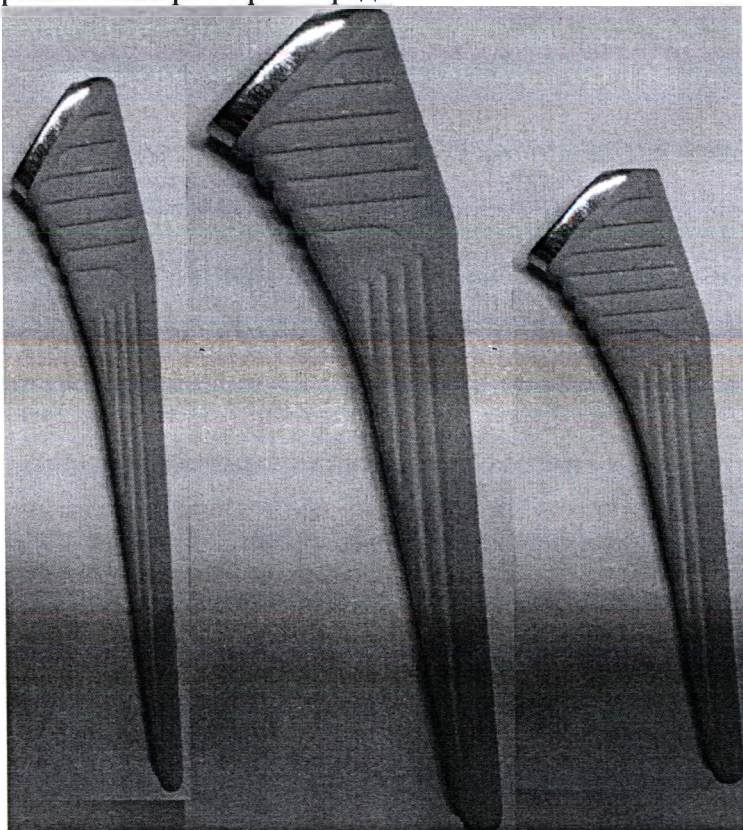

Головка керамическая, Ø32мм. Глубина посадки: -4мм, 0, +4мм, 38.39.7175.665.00, 38.39.7175.675.00, 38.39.7175.685.00.

Фотография общего вида медицинского изделия разного типоразмерного ряда.

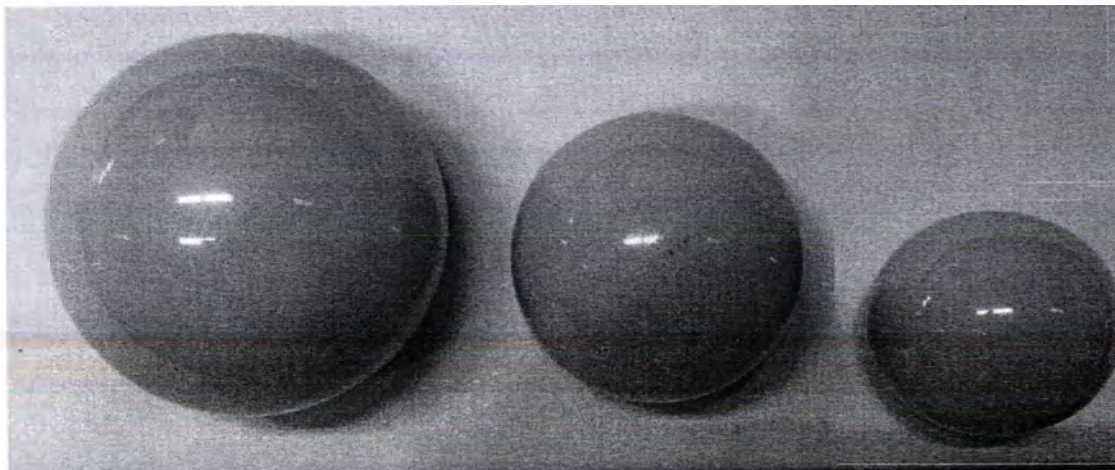


«010.000.00 – Эндопротез головки лучевой кости и инструменты для их установки

Фотография стерильного изделия по ТУ 9438-002-58261811-2008.


Изделие, поставляемое стерильным, должно быть упаковано в индивидуальную тройную упаковку по ГОСТ ISO 11607, изготовленную из пленки по ГОСТ 10354, и герметично заварено, так, чтобы сохранился исходный уровень стерильности в нормальных условиях хранения, транспортирования и обращения, за исключением случаев, когда упаковка, обеспечивающая стерильность, повреждена или вскрыта



Эндопротез головки лучевой кости, Ø16мм, 10.018.06, 10.018.08, 10.018.12
Фотография общего вида медицинского изделия разного типоразмерного ряда.

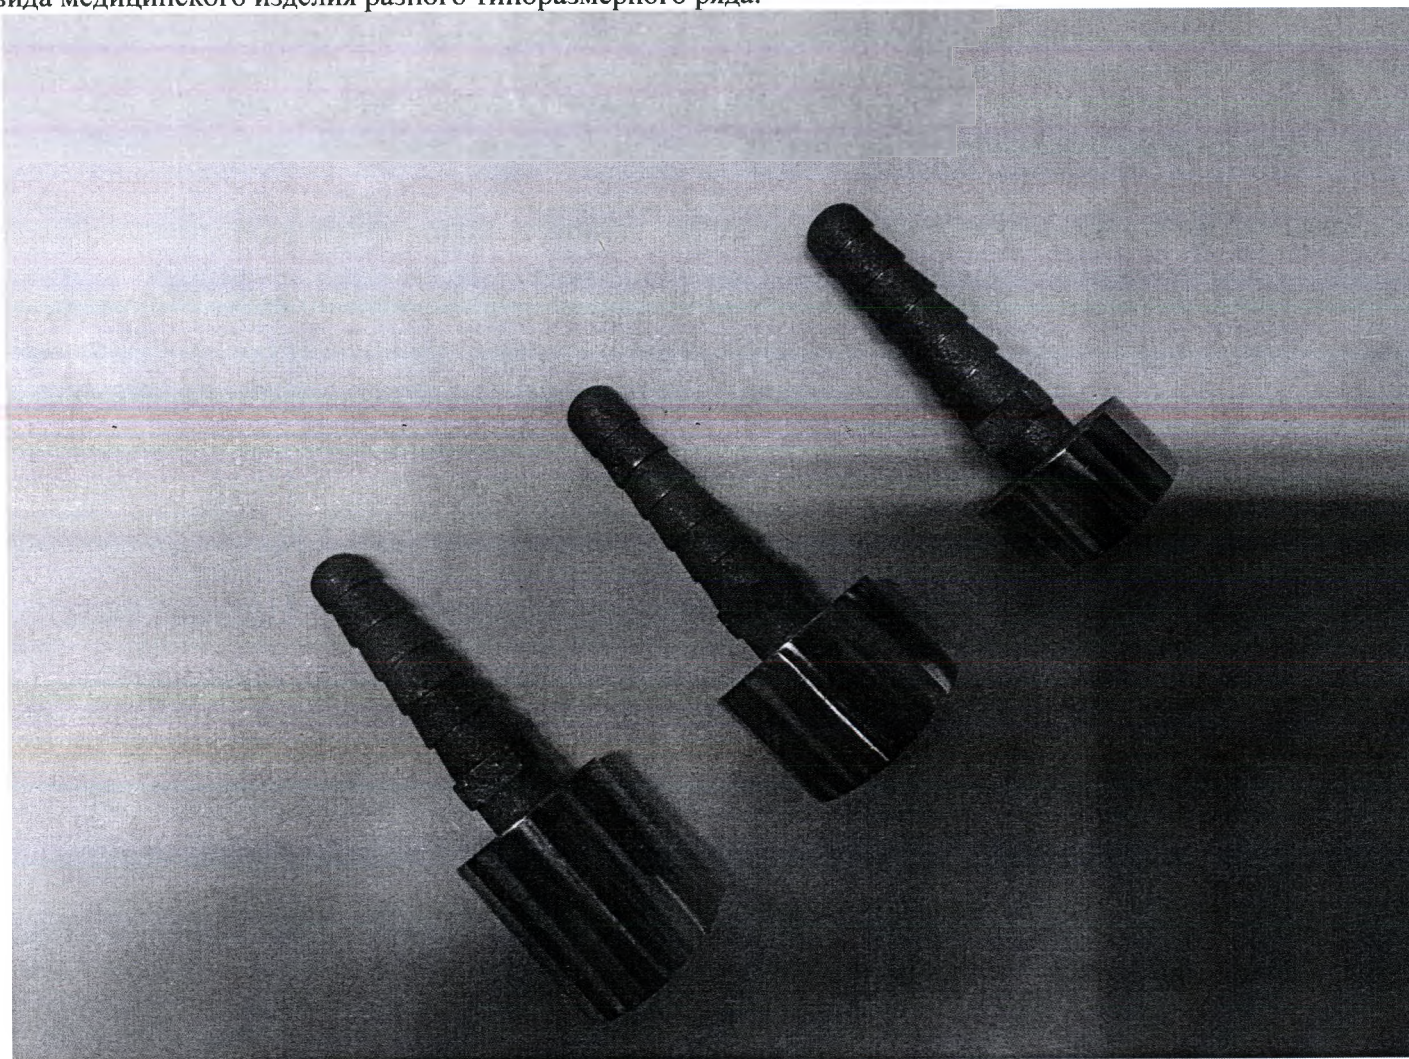

Фотография изделия. Маркировка этикетки по пунктам 1.5.10, 1.5.11ТУ 9438-002-58261811-2008. Изделие упаковано по пунктам 1.6.2, 1.6.3 ТУ 9438-002-58261811-2008

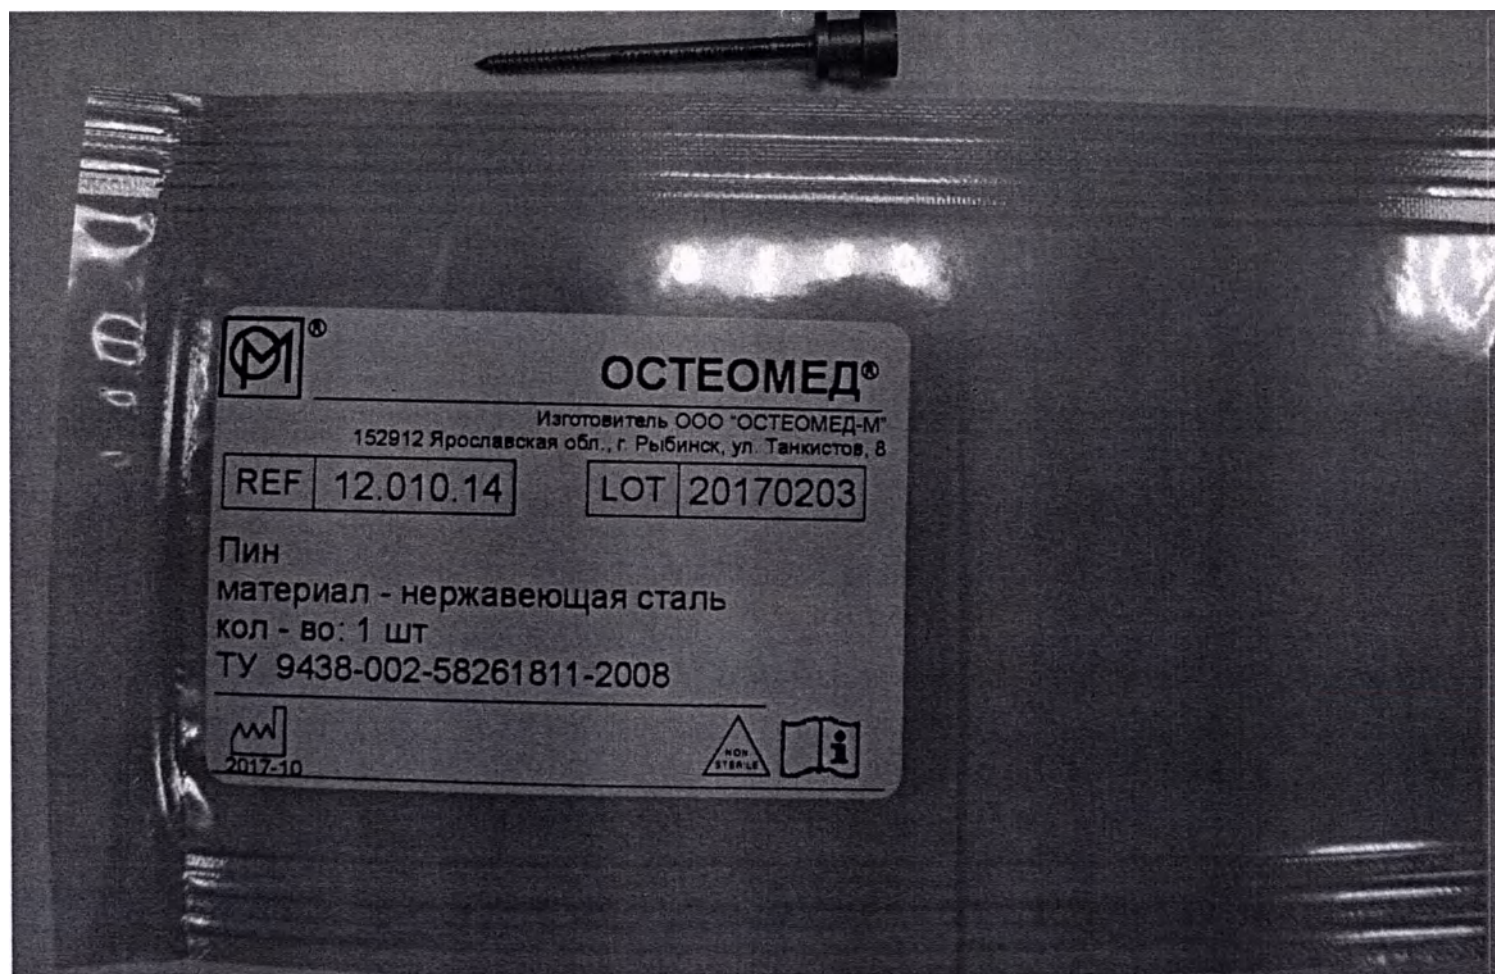



Генеральный инспектор ООО
"ОСТЕОМЕД-М"
Холмакин Д.А.

С. С. Сидорова