



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "Реагент"

В.В. Жарков
2018 г.

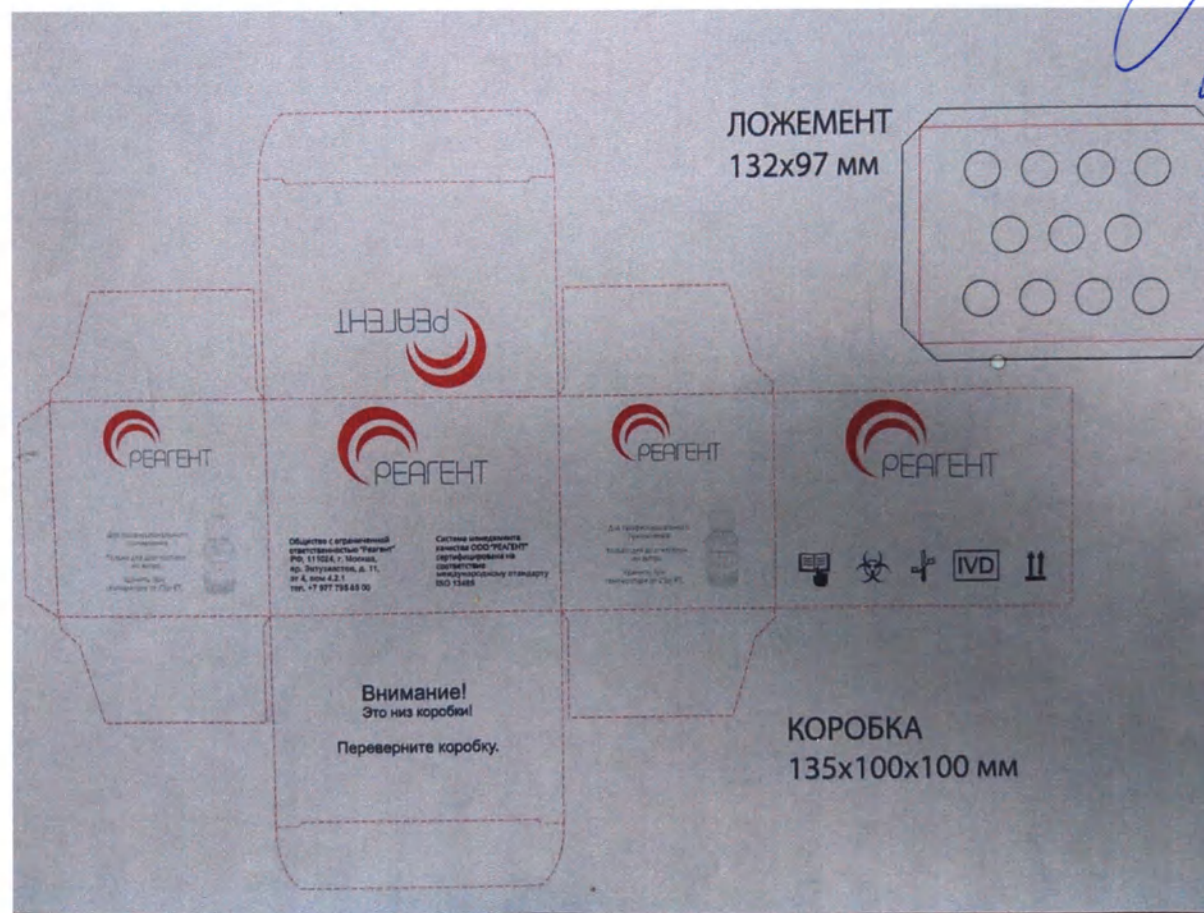



Коробка Комплектов №1, №2

Универсальная коробка

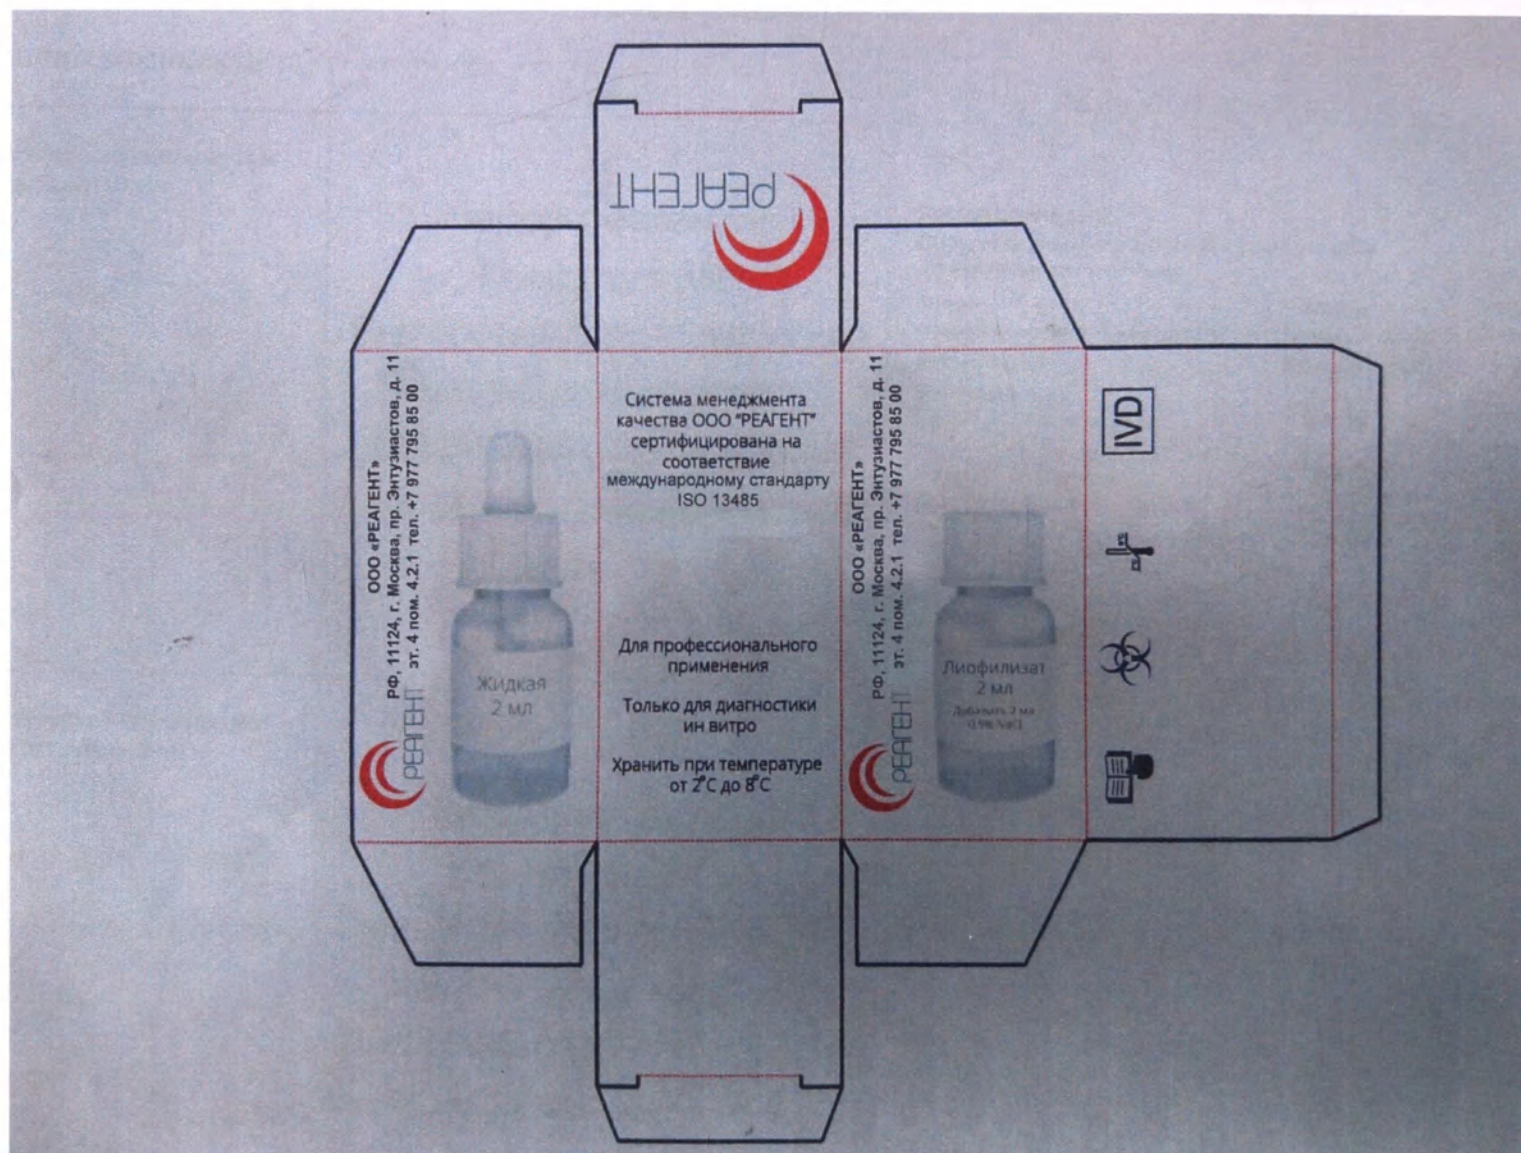

Этикетки для маркировки комплектов сыворотки диагностической шигеллезной

**КОПИЯ
ВЕРНА**

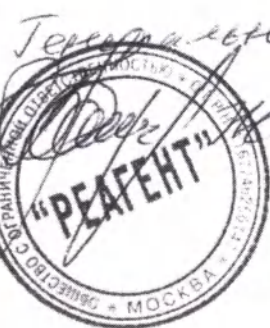Наименование комплекта	Коробка		Флаконы
	Лицевая	Информационная	
Комплект № 1 Сыворотки диагностические шигеллезные сухие для реакции агглютинации.	Набор реагентов Комплект №1 Сыворотки диагностические шигеллезные сухие для реакции агглютинации Серия: 011117 Срок годности:11.2022	Состав комплекта: Сыворотки диагностические шигеллезные сухие для реакции агглютинации. Зонне 1 флакон 2 мл Поливалентная Флекснера I-V 1 флакон 2 мл Флекснера VI 1 флакон 2 мл Поливалентная (Зонне и Флекснера I-VI) 1 флакон 2 мл ТУ 21 10.60-001-00548407-2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017г 	 ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации сухая Зонне Добавить 2 мл 0.9% натрия хлорида Серия 011117 Срок годности 11.2022  ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации сухая Поливалентная Флекснера I-V Добавить 2 мл 0.9% натрия хлорида Серия 011117 Срок годности 11.2022  ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации сухая Флекснера VI Добавить 2 мл 0.9% натрия хлорида Серия 011117 Срок годности:11.2022  ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации сухая Поливалентная (Зонне, Флекснера I-VI) Добавить 2 мл 0.9% натрия хлорида Серия 011117 Срок годности 11.2022  ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации жидкая
Комплект № 2 Сыворотки диагностические шигеллезные жидкие для реакции агглютинации. Утверждено Генеральный директор  Марков В.В.	Набор реагентов Комплект №2 Сыворотки диагностические шигеллезные жидкие для реакции агглютинации Серия: 011117 Срок годности: 11.2020	Состав комплекта: Сыворотки диагностические шигеллезные жидкие для реакции агглютинации: Зонне 1 флакон 2 мл Поливалентная Флекснера I-V 1 флакон 2 мл Флекснера VI 1 флакон 2 мл Поливалентная (Зонне и Флекснера I-VI) 1 флакон 2 мл ТУ 21 10.60-001-00548407-2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017г 	 ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации жидкая Зонне 2 мл Готова к применению Серия 011117 Срок годности 11.2020  ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации жидкая Поливалентная Флекснера I-V 2 мл Готова к применению Серия 011117 Срок годности 11.2020  ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации жидкая Флекснера VI 2 мл Готова к применению Серия 011117 Срок годности 11.2020  ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации жидкая Поливалентная (Зонне, Флекснера I-VI) 2 мл Готова к применению Серия 011117 Срок годности 11.2020

Комплект № 3 Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая Зонне для реакции агглютинации.	Набор реагентов Комплект №3 Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая для реакции агглютинации Зонне 1 флакон 2 мл Серия 061117 Срок годности 11.2022	TV 21 10.60.001.00548407 2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017 4 627132 480010	ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации, сухая Зонне Добавить: 2 мл 0.9% - натрия хлорида Серия 061117 Срок годности 11.2022
Комплект № 4 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая Зонне для реакции агглютинации.	Набор реагентов Комплект №4 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая для реакции агглютинации Зонне 1 флакон 2 мл Серия 081117 Срок годности 11.2020	TV 21 10.60.001.00548407 2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017 4 627132 480041	ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации, жидкая Зонне 2 мл Готова к применению Серия 081117 Срок годности 11.2020
Комплект № 5 Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая поливалентная Флекснера I-V для реакции агглютинации.	Набор реагентов Комплект №5 Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая для реакции агглютинации Поливалентная 1 флакон Флекснера I-V 2 мл Серия 101117 Срок годности 11.2022	TV 21 10.60.001.00548407 2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017 4 627132 480058	ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации, сухая Флекснера VI Добавить: 2 мл 0.9% - натрия хлорида Серия 141117 Срок годности 11.2022
Комплект № 6 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая поливалентная Флекснера I-V для реакции агглютинации.	Набор реагентов Комплект №6 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая для реакции агглютинации Поливалентная 1 флакон Флекснера I-V 2 мл Серия 121117 Срок годности 11.2020	TV 21 10.60.001.00548407 2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017 4 627132 480065	ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации, жидкая Поливалентная Флекснера I-V 2 мл Готова к применению Серия 121117 Срок годности 11.2020
Комплект № 7 Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая Флекснера VI для реакции агглютинации.	Набор реагентов Комплект №7 Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая для реакции агглютинации Флекснера VI 1 флакон 2 мл Серия 141117 Срок годности 11.2022	TV 21 10.60.001.00548407 2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017 4 627132 480072	ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации, сухая Поливалентная Флекснера I-V Добавить: 2 мл 0.9% - натрия хлорида Серия 101117 Срок годности 11.2022
Комплект № 8 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая Флекснера VI для реакции агглютинации.	Набор реагентов Комплект №8 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая для реакции агглютинации Флекснера VI 1 флакон 2 мл Серия 161117 Срок годности 11.2020	TV 21 10.60.001.00548407 2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017 4 627132 480089	ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации, жидкая Флекснера VI 2 мл Готова к применению Серия 161117 Срок годности 11.2020
Комплект № 9 Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая поливалентная (Зонне и Флекснера I- VI) для реакции агглютинации.	Набор реагентов Комплект №9 Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая для реакции агглютинации Поливалентная 1 флакон (Зонне, Флекснера I-VI) 2 мл Серия 181117 Срок годности 11.2022	TV 21 10.60.001.00548407 2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017 4 627132 480096	ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации, сухая Поливалентная (Зонне, Флекснера I-VI) Добавить: 2 мл 0.9% - натрия хлорида Серия 181117 Срок годности 11.2022
Комплект № 10 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая поливалентная (Зонне Флекснера I- VI) для реакции агглютинации.	Набор реагентов Комплект №10 Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая для реакции агглютинации Поливалентная 1 флакон (Зонне, Флекснера I-VI) 2 мл Серия 201117 Срок годности 11.2020	TV 21 10.60.001.00548407 2017 Р №ФСР 2017/00000 Дата регистрации 00.00.2017 4 627132 480102	ООО "РЕАГЕНТ" Сыворотка диагностическая шигеллезная для реакции агглютинации, жидкая Поливалентная (Зонне, Флекснера I-VI) 2 мл Готова к применению Серия 201117 Срок годности 11.2020

ПРИНУЖДЕНО
ПРОШТО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
четыре 4 ЛИСТОВ
АГЕНТ
МОСКВА

Фотография

Набор реагентов: «Сыворотки диагностические шигеллезные сухие для реакции агглютинации»

Комплект № 1

КОПИЯ
ВЕРНА



Фотография

Набор реагентов: «Сыворотки диагностические шигеллезные жидкие для реакции агглютинации»

Комплект № 2



Фотография
Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая Зонне для реакции агглютинации»
Комплект № 3



Фотография

Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая Зонне для реакции агглютинации»


Комплект № 4



Фотография

Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая поливалентная Флекснера I-V для реакции агглютинации»

Комплект № 5

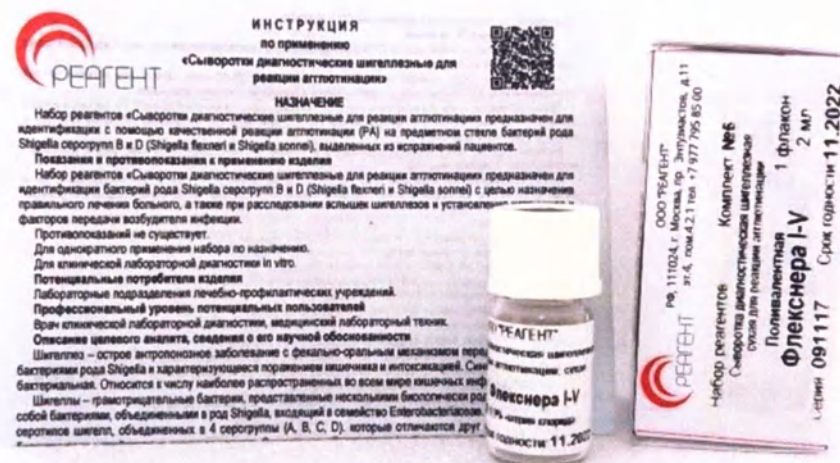

Фотография


Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая поливалентная Флекснера I-V для реакции агглютинации»
Комплект № 6



Фотография

Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая Флекснера VI для реакции агглютинации»


Комплект № 7

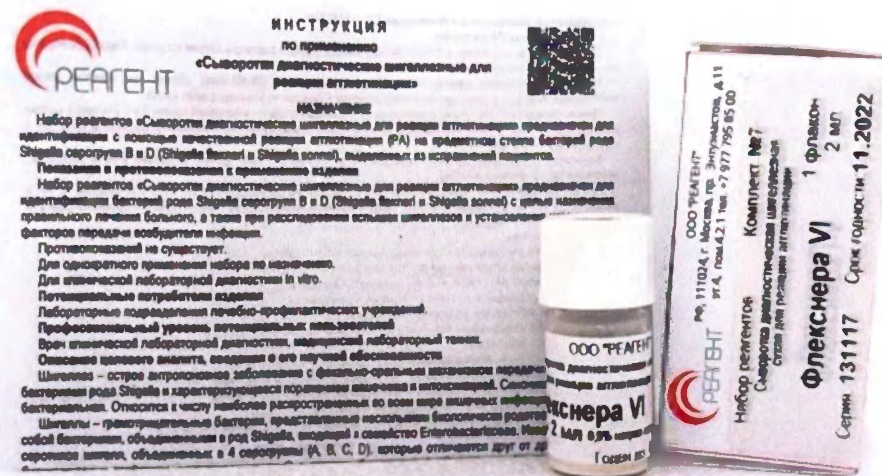

Фотография


Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая Флекснера VI для реакции агглютинации»

Комплект № 8

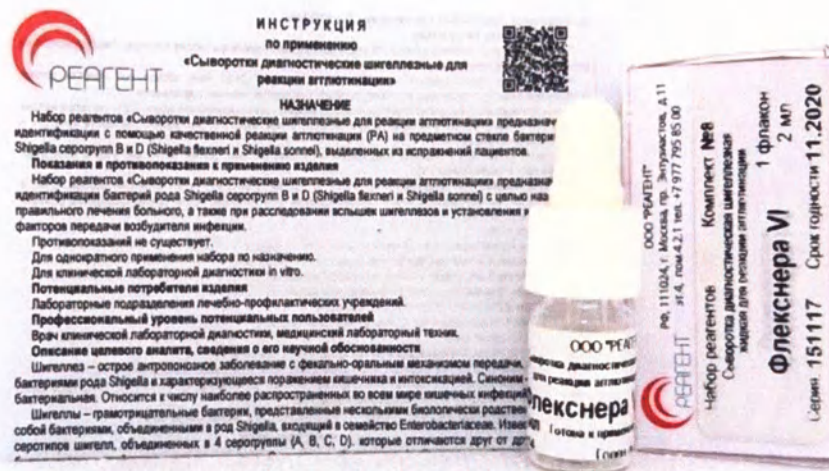


Фотография

Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая шигеллезная сухая поливалентная (Зонне, Флекснера I-VI) для реакции агглютинации»
Комплект № 9

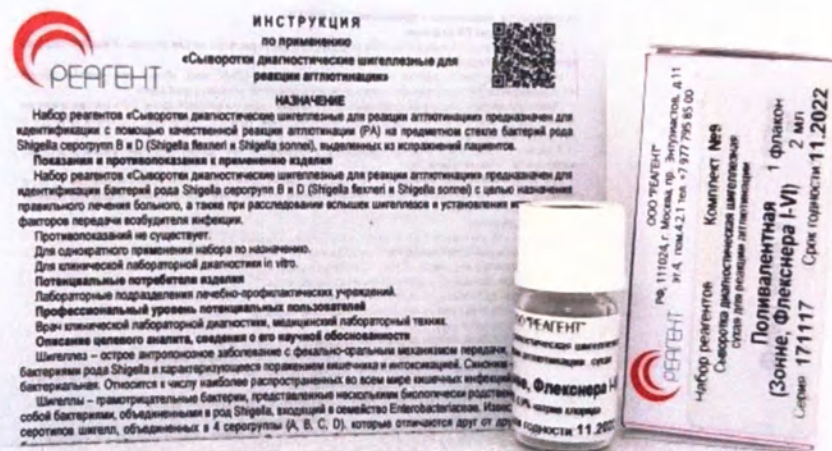

Фотография
Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая шигеллезная жидкая поливалентная (Зонне, Флекснера I-VI) для реакции агглютинации»
Комплект № 10





Исх. № 100/100
Директор
Исх. № 100/100