



КОПИЯ
ВЕРНА

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "Реагент"




К. Г. Акуленок
2013 г.

ЛОЖЕМЕНТ
132x97 мм

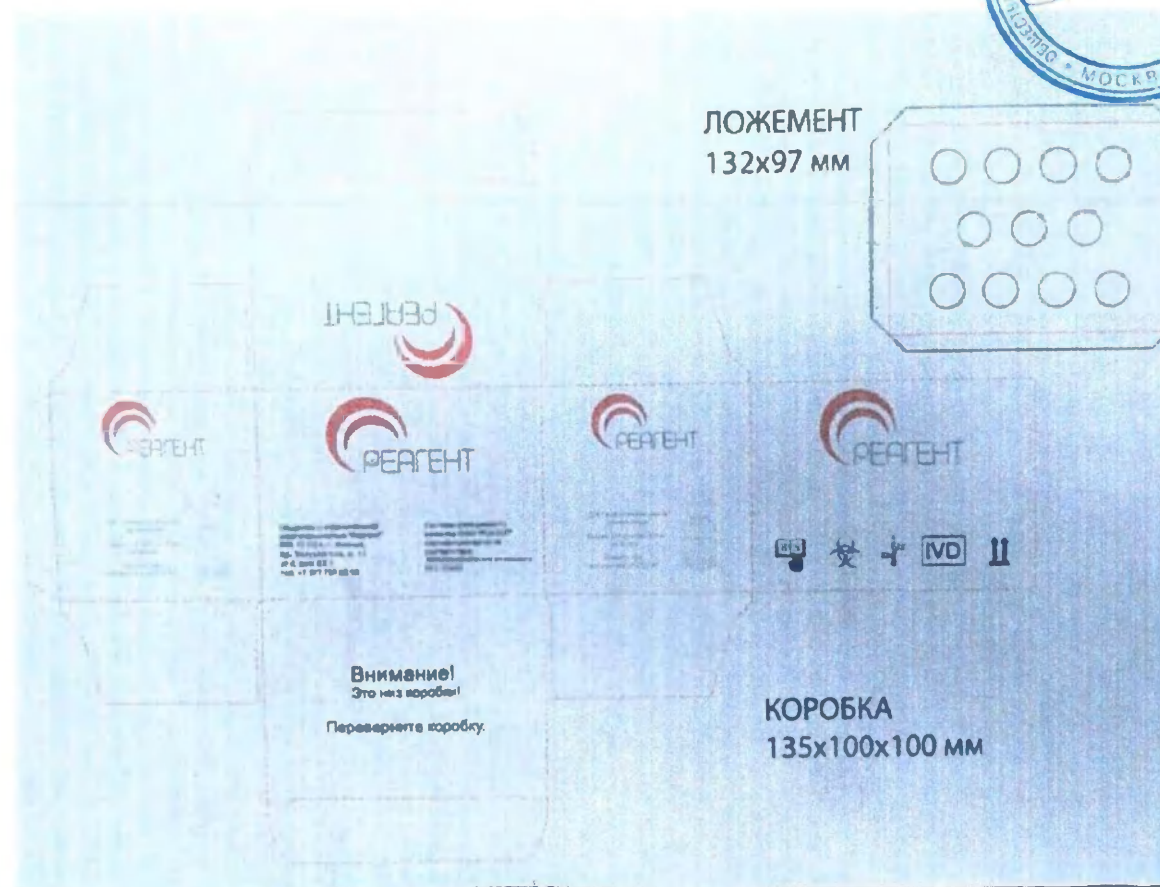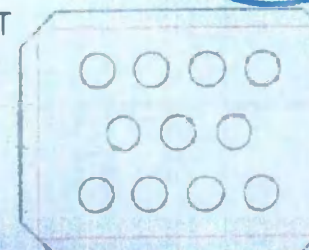

Коробка Комплектов №1, №2

Универсальная коробка

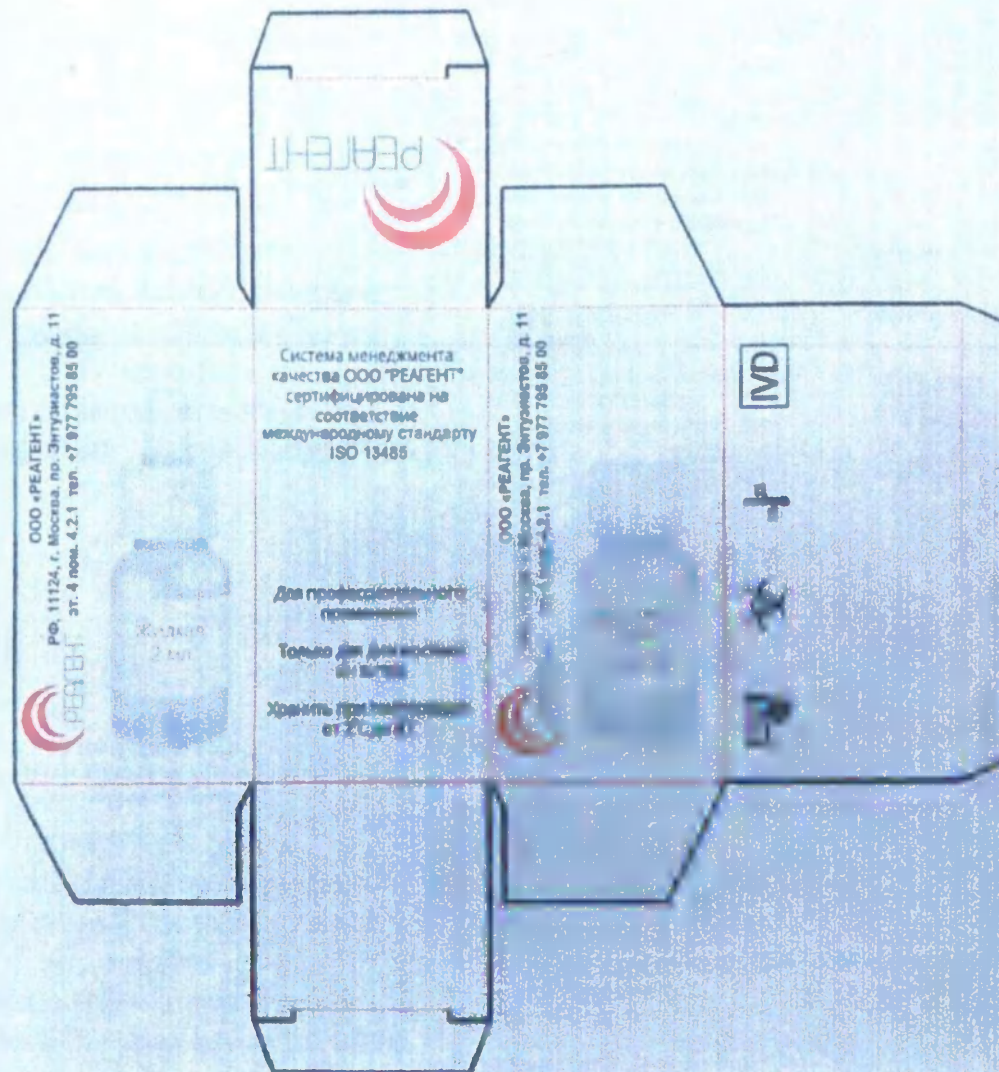

Этикетки для маркировки комплектов сыворотки диагностической коклюшной и паракоклюшной

Наименование комплекта	Коробка		Флаконы
	Лицевая	Информационная	
Комплект № 1 Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации	Набор реагентов "Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные для реакции агглютинации" Комплект №1 Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации Серия: 000000 Срок годности: 00.0000	Состав комплекта: Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации Сыворотка диагностическая коклюшная сухая для реакции агглютинации 1, 2, 3 1 флакон 2 мл Сыворотка диагностическая паракоклюшная сухая для реакции агглютинации 14 1 флакон 2 мл ТУ 21 20 23-002-00548407-2019 Р № РЗН 0000/0000 Дата регистрации 00 00 2000г 	КОМПЛЕКТ №1 Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации 1 флакон 2 мл КОМПЛЕКТ №1 Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации 1 флакон 2 мл Серия: 000000 Срок годности: 00.0000
Комплект № 2 Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные жидкие для реакции агглютинации	Набор реагентов "Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные для реакции агглютинации" Комплект №2 Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные жидкие для реакции агглютинации Серия: 000000 Срок годности: 00.0000	Состав комплекта: Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные жидкие для реакции агглютинации Сыворотка диагностическая коклюшная жидкая для реакции агглютинации 1, 2, 3 1 флакон 2 мл Сыворотка диагностическая паракоклюшная жидкая для реакции агглютинации 14 1 флакон 2 мл ТУ 21 20 23-002-00548407-2019 Р № РЗН 0000/0000 Дата регистрации 00 00 2000г 	КОМПЛЕКТ №2 Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные жидкие для реакции агглютинации 1 флакон 2 мл КОМПЛЕКТ №2 Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные жидкие для реакции агглютинации 1 флакон 2 мл Серия: 000000 Срок годности: 00.0000

Комплект № 3 Сыворотка диагностическая коклюшная сухая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации.	Комплект №3 Сыворотка диагностическая коклюшная сухая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации Серия 000000 Срок годности 00.0000	История регистрации Удостоверение в качестве сертифицированного для реакции агглютинации	ТУ 21.20.23.002-00548407-2019 Р № РЗН 00000000 Дата регистрации 00.00.2000 4 627132 480133	QR	ООО "ЦИРМИ" Сыворотка диагностическая коклюшная сухая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации 2 мл Срок годности 00.0000
Комплект № 4 Сыворотка диагностическая коклюшная жидкая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации.	Комплект №4 Сыворотка диагностическая коклюшная жидкая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации Серия 000000 Срок годности 00.0000	История регистрации Удостоверение в качестве сертифицированного для реакции агглютинации	ТУ 21.20.23.002-00548407-2019 Р № РЗН 00000000 Дата регистрации 00.00.2000 4 627132 480140	QR	ООО "ЦИРМИ" Сыворотка диагностическая коклюшная жидкая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации 2 мл Срок годности 00.0000
Комплект № 5 Сыворотка диагностическая паракоклюшная сухая к агглютиногену 14 для реакции агглютинации.	Комплект №5 Сыворотка диагностическая паракоклюшная сухая к агглютиногену 14 для реакции агглютинации Серия 000000 Срок годности 00.0000	История регистрации Удостоверение в качестве сертифицированного для реакции агглютинации	ТУ 21.20.23.002-00548407-2019 Р № РЗН 00000000 Дата регистрации 00.00.2000 4 627132 480157	QR	ООО "ЦИРМИ" Сыворотка диагностическая паракоклюшная сухая к агглютиногену 14 для реакции агглютинации 2 мл Срок годности 00.0000
Комплект № 6 Сыворотка диагностическая паракоклюшная жидкая к агглютиногену 14 для реакции агглютинации.	Комплект №6 Сыворотка диагностическая паракоклюшная жидкая к агглютиногену 14 для реакции агглютинации Серия 000000 Срок годности 00.0000	История регистрации Удостоверение в качестве сертифицированного для реакции агглютинации	ТУ 21.20.23.002-00548407-2019 Р № РЗН 00000000 Дата регистрации 00.00.2000 4 627132 480164	QR	ООО "ЦИРМИ" Сыворотка диагностическая паракоклюшная жидкая к агглютиногену 14 для реакции агглютинации 2 мл Срок годности 00.0000



*Генеральный директор
ОАО РЕАГЕНТ
А.И. К.Г.*

Фотография
Набор реагентов: «Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации»
Комплект № 1

КОПИЯ
ВЕРНА



ИНСТРУКЦИЯ

Информация набора реагентов
«Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации»



Набор реагентов «Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации» предназначен для идентификации и титрования антигенов (РА) на твердых и жидких средах. Набор реагентов «Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации» предназначен для идентификации и титрования антигенов (РА) на твердых и жидких средах. Набор реагентов «Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации» предназначен для идентификации и титрования антигенов (РА) на твердых и жидких средах.

Применение: для идентификации и титрования антигенов (РА) на твердых и жидких средах. Набор реагентов «Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации» предназначен для идентификации и титрования антигенов (РА) на твердых и жидких средах. Набор реагентов «Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации» предназначен для идентификации и титрования антигенов (РА) на твердых и жидких средах.




Набор реагентов
«Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации»

Комплект №1
Сыворотки диагностические коклюшные и паракоклюшные сухие для реакции агглютинации
Серия: 010119 Срок годности: 01.2024

Фотография

Набор реагентов: «Сыворотки диагностические коклюшные и паракклюшные жидкие для реакции агглютинации»
Комплект № 2

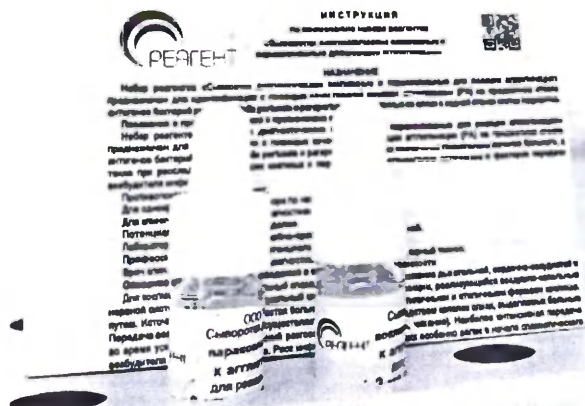

Набор реагентов
«Сыворотки диагностические коклюшные и паракклюшные
для реакции агглютинации»

Комплект №2
Сыворотки диагностические
коклюшные и паракклюшные
жидкие
для реакции агглютинации
Серия: 030119 Срок годности: 01.2022

Фотография
Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая коклюшная сухая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации»
Комплект № 3



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая коклюшная и
паракоклюшная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая коклюшная и паракоклюшная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Corynebacterium* и *Paracorynebacterium*, выделенных из смывов с задней стенки глотки пациентов.

Показания и противопоказания к применению изделия

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая коклюшная и паракоклюшная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Corynebacterium* и *Paracorynebacterium* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологических случаев коклюша и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Противопоказаний нет

Для одноразового применения

Для клинической лабораторной диагностики

Потенциальные потребности

Лабораторные подразделения

Профессиональный уровень

Врачи клинической лаборатории

Описание целевого назначения

Для коклюша характерна циклическая эпидемиология. Заболевание проявляется в виде приступов кашля. Источниками инфекции являются больные коклюшем. Передача возбудителя инфекции происходит воздушно-капельным путем. В период усиленного выделения возбудителя происходит передача инфекции.

назо-фарингеальной слизи.

лабораторной диагностики

пользоваться

для клинической лабораторной диагностики

с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании эпидемиологических случаев коклюша и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

для коклюша характерна циклическая эпидемиология. Заболевание проявляется в виде приступов кашля. Источниками инфекции являются больные коклюшем. Передача возбудителя инфекции происходит воздушно-капельным путем. В период усиленного выделения возбудителя происходит передача инфекции.

для коклюша характерна циклическая эпидемиология. Заболевание проявляется в виде приступов кашля. Источниками инфекции являются больные коклюшем. Передача возбудителя инфекции происходит воздушно-капельным путем. В период усиленного выделения возбудителя происходит передача инфекции.

для коклюша характерна циклическая эпидемиология. Заболевание проявляется в виде приступов кашля. Источниками инфекции являются больные коклюшем. Передача возбудителя инфекции происходит воздушно-капельным путем. В период усиленного выделения возбудителя происходит передача инфекции.

для коклюша характерна циклическая эпидемиология. Заболевание проявляется в виде приступов кашля. Источниками инфекции являются больные коклюшем. Передача возбудителя инфекции происходит воздушно-капельным путем. В период усиленного выделения возбудителя происходит передача инфекции.



Комплект №3

Сыворотка диагностическая коклюшная сухая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации

Серия: 050119

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 977 795 85 00

Набор реагентов

«Сыворотка диагностическая коклюшная сухая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2024

Фотография
Набор реагентов «Сыворотка диагностическая коклюшная жидкая поливалентная к агглютиногенам 1, 2, 3 для реакции агглютинации»
Комплект № 4



ИНСТРУКЦИЯ
 по применению набора реагентов
 «Сыворотки диагностические коклюшные и паракокклюшные для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

сыворотки коклюшные и паракокклюшные для реакции агглютинации»
 качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле
 с целью выявления на стекле с задней стороны пятен пациентов,
 миню издала
 сыворотки коклюшные и паракокклюшные для реакции агглютинации»
 качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле
 с целью назначения правильного лечения больного, а
 коклюша и установления источников и факторов передачи

Набор реагентов «Сыворотка
 предназначен для идентификации
 антигенов бактерий рода *Bordetella*

Показания и противопоказания

Набор реагентов «Сыворотка
 предназначен для идентификации
 антигенов бактерий рода *Bordetella*
 также при исследовании
 возбудителя инфекции.

Противопоказаний не су

Для однократного приме

Для клинической лабора

Потенциальные потре

Лабораторные подразделени

Профессиональный упр

Врачи клинической лабора

Описание целевого ана

Для коклюша характерн


нерной систем. Задает

путем. Источником инфек

Передача возбудителя инф

во время усиленного выдо

возбудителя происходит при

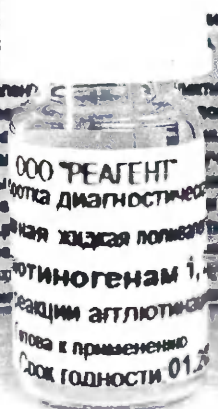

Комплект №4

**Сыворотка диагностическая
 коклюшная жидкая
 поливалентная к
 агглютиногенам 1, 2, 3
 для реакции агглютинации**

Серия 070119

ООО "РЕАГЕНТ"

РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
 эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 977 795 85 00

Набор реагентов

«Сыворотки диагностические
 коклюшные и паракокклюшные»
 для реакции агглютинации»

1 флакон

2 мл

Срок годности: 01.2022

Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая паракклюшная сухая к агглютиногену 14 для реакции агглютинации»
Комплект № 5



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая коклюшная и
паракоклюшная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая коклюшная и паракклюшная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Bordetella pertussis* и *B. paraptussis*, выделенных из слизи с задней стенки глотки пациентов.

Показания и противопоказания к применению изделия

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая коклюшная и паракклюшная для реакции агглютинации» предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода *Bordetella pertussis* и *B. paraptussis* с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании возбудителя инфекции и установления источников и факторов передачи.

Противопоказаний

Для одноразового

Для клинической

Потенциальные

Лабораторные подраз

Профессиональные

Врачи клинической

Описание целевого

Для коклюша харак

нерной систем. Задей

путем. Источниками

Передача возбудите

во время усиленного

возбудителя происхо

инфекции
in vitro.

профилакти

ных пол

и, введ

го науч

тически

ханизм

не (дет

и чер

и, при

ирова



ООО «РЕАГЕНТ»
РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 977 795 85 00

Комплект №5
Сыворотка диагностическая
паракоклюшная сухая
к агглютиногену 14
для реакции агглютинации
Серия 090119 Срок годности 01.2024

Набор реагентов
«Сыворотка диагностическая
коклюшная и паракклюшная
для реакции агглютинации»

1 флакон
2 мл

**Набор реагентов: «Сыворотка диагностическая параклоушная жидкая к агглютиногену 14 для реакции агглютинации»
Комплект № 6**




ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотка диагностическая коклюшная и
паракоклюшная для реакции агглютинации»



НАЗНАЧЕНИЕ

Возбудитель коклюша и паракклюша для реакции агглютинации
с целью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле
или в реактивах, выделенных из слизи с задней стенки глотки пациента.
именно издается
с целью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле
реактивах с целью назначения правильного лечения больного, а
и паракклюша и установления источника и факторов передачи

Набор реагентов «С»
предназначен для иденти-
фикации антигенов бактерий рода I
Показания и противопо-
казания
Набор реагентов «С»
предназначен для иден-
тификации антигенов бактерий
также при распадах
возбудителя инфекции
Противопоказания
Для однократной
Для клинической
Потенциальные
Лабораторные подры-
Профессионалы
Врачи клинической
Описание целей
Для коклюша хар-
актерной системы. Забо-
левание. Источником
Передача возбудите-
ля во время удушья
возбудителя происхо-

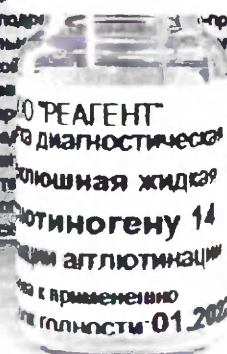

Комплект №6
Сыворотка диагностическая
паракоклюшная жидкая
к агглютиногену 14
для реакции агглютинации
Серия 110119

ООО "РЕАГЕНТ"
РФ, 111024, г. Москва, пр. Энтузиастов, д.11
эт.4, пом.4.2.1 тел. +7 977 795 85 00

Набор реагентов
«Сыворотка диагностическая
коклюшная и паракклюшная
для реакции агглютинации»

1 флакон
2 мл

Срок годности. 01.2022

Генеральный директор ООО "РЕАГЕНТ"

К.Г. Акуленок

Исполнитель к.т.
С.И. Сидорова
"ПРАВИТЕЛЬСТВО"
ПРОЦЕДУРА
ОБЪЕКТА
ПРОЦЕДУРА
ОБЪЕКТА
ПРОЦЕДУРА
ОБЪЕКТА