

Фотографии медицинского изделия:

«Инкубатор реанимационный для новорожденных VISION®ADVANCED 2286 с принадлежностями»

производство: «ФАНЕМ ЛТДА», Бразилия / FANEM LTDA, Brazil.

1. Инкубатор VISION®ADVANCED, общий вид.
2. Лоток выдвижной для рентгеновской кассеты.
3. Увлажнитель.
4. Матрац.
5. Весы неонатальные.
6. Сервоконтроль температуры кожи, воздуха, влажности, кислорода.
7. Датчик температуры кожи.
8. Датчик температуры кожи периферический.
9. Датчик температуры воздуха.
10. Датчик влажности.
11. Датчик концентрации кислорода.
12. Порт овальный.
13. Порт типа «ирис».
14. Втулка, изолирующая для шлангов и кабелей.
15. Стойка вертикальная для в/в инфузий.
16. Ящик выдвижной; ящик с дверцей.
17. Полка поворотная.
18. Фильтр воздушный.
19. Пластырь для фиксации датчика температуры кожи.
20. Рукав порта овального для манипуляций.
21. Рукав порта типа «ирис».
22. Резервуар увлажнителя.
23. Подушка неонатальная для фиксации головы.
24. Шлем акриловый с кислородным клапаном.
25. Пульсоксиметр неонатальный с кабелем.

27. Лампа фототерапии с креплением на инкубатор.
28. Плата съемная электронная управления узлами инкубатора.
29. Блок съемный электронный контролирующий для инкубатора.
30. Блок питания.
31. Флоуметр для кислорода с редуктором.

Коммерческий директор ООО «РИПЛ»
(должность)

(подпись и печать Заявителя)

В.В. Пометун
(И.О.Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «РИПЛ» (ООО «РИПЛ»)
(наименование организации-заявителя)

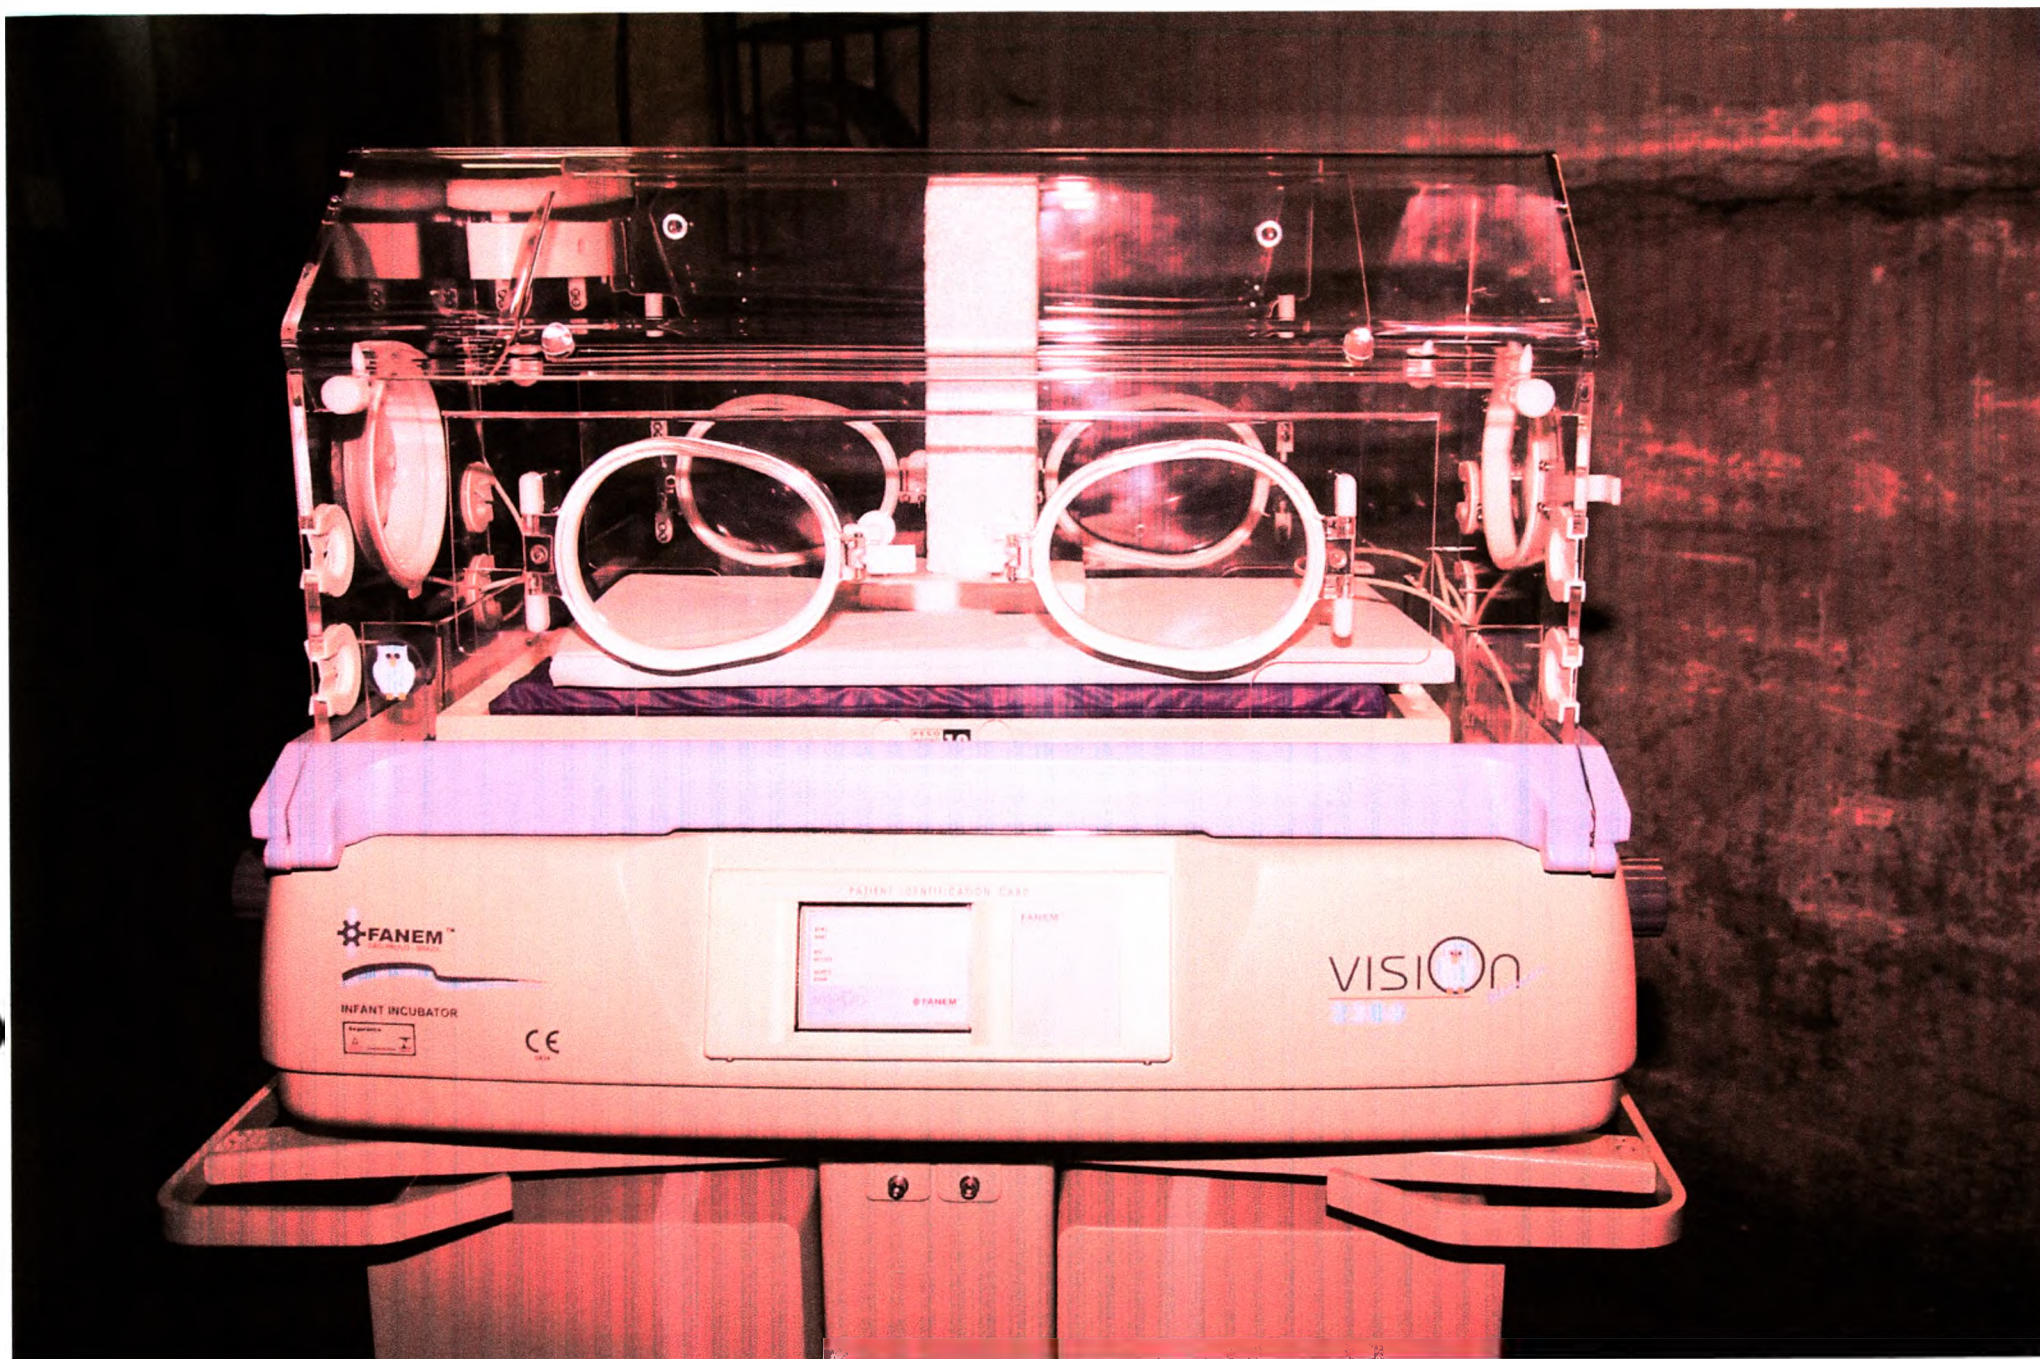


Рис. 1. Инкубатор VISION®ADVANCED, общий вид.

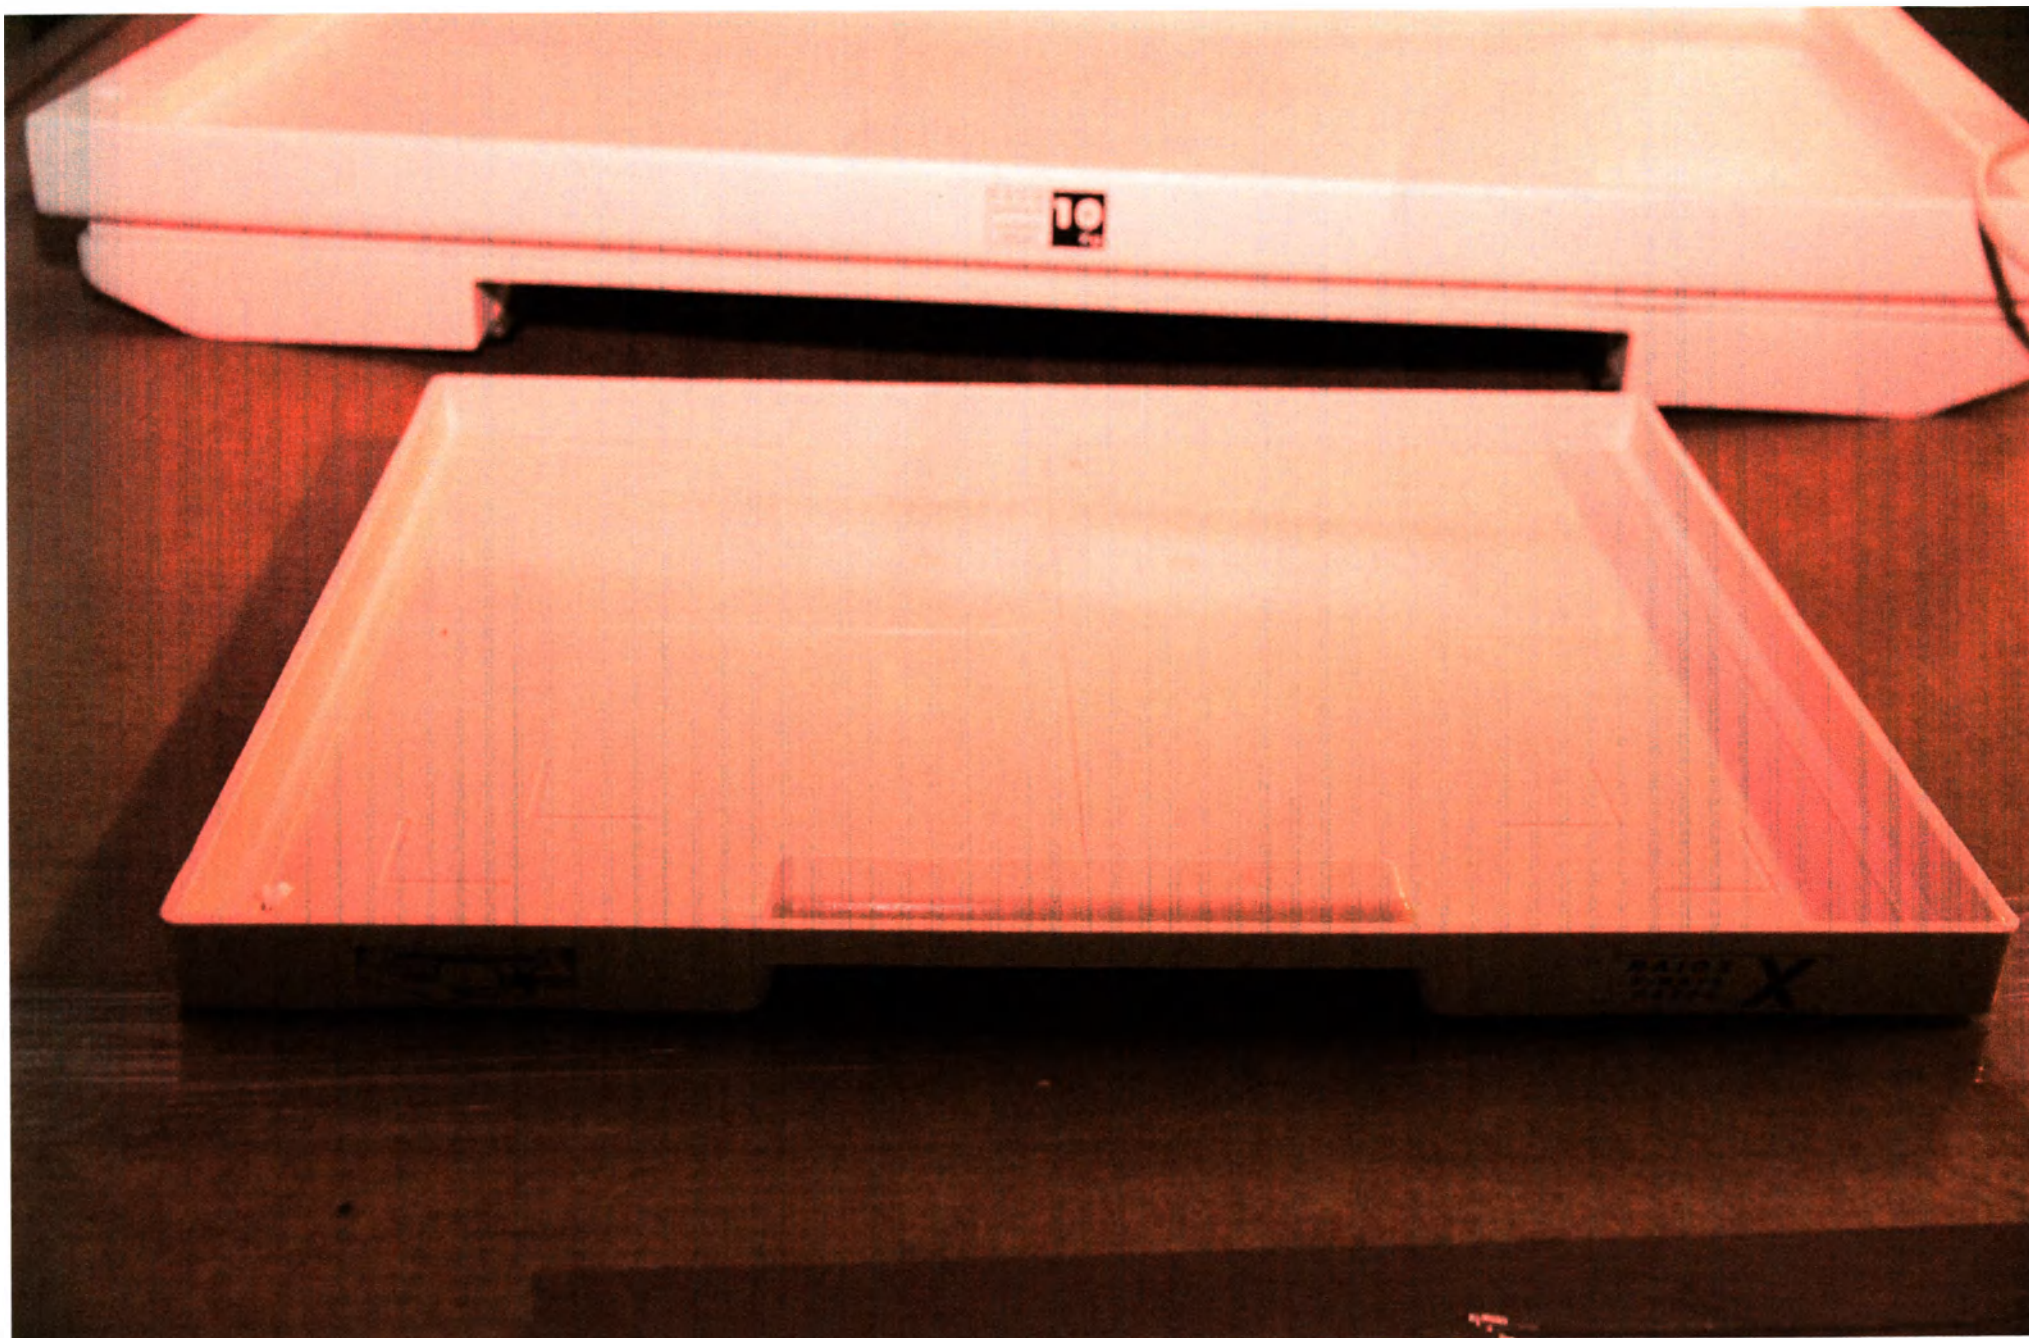


Рис. 2. Лоток выдвижной для рентгеновской кассеты.

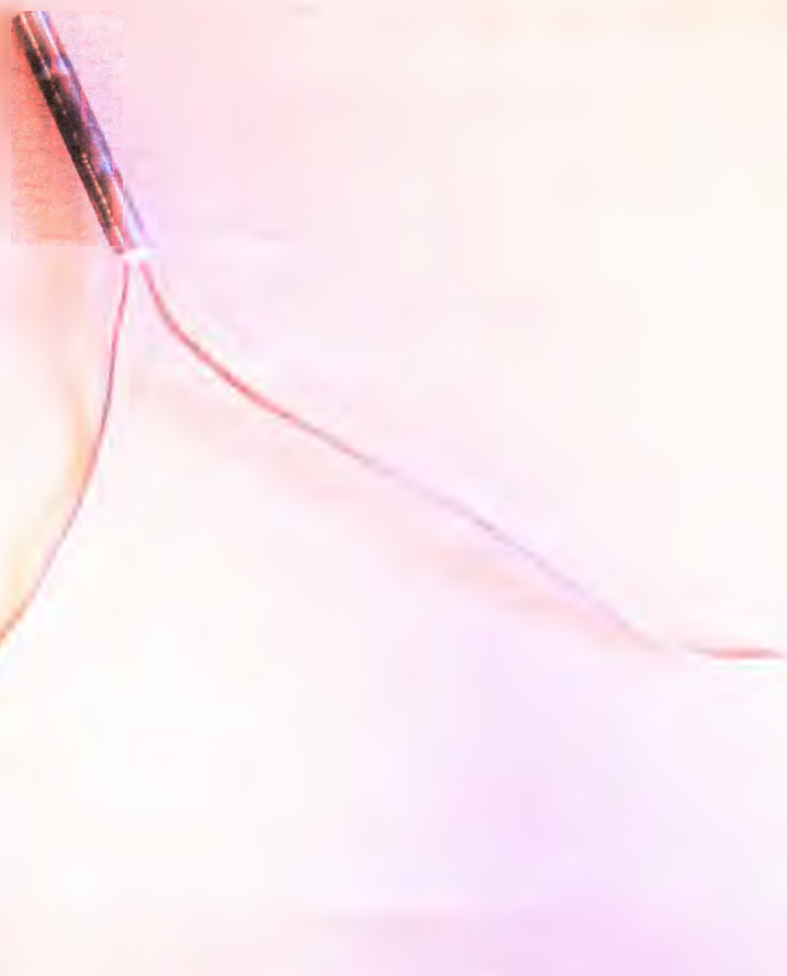
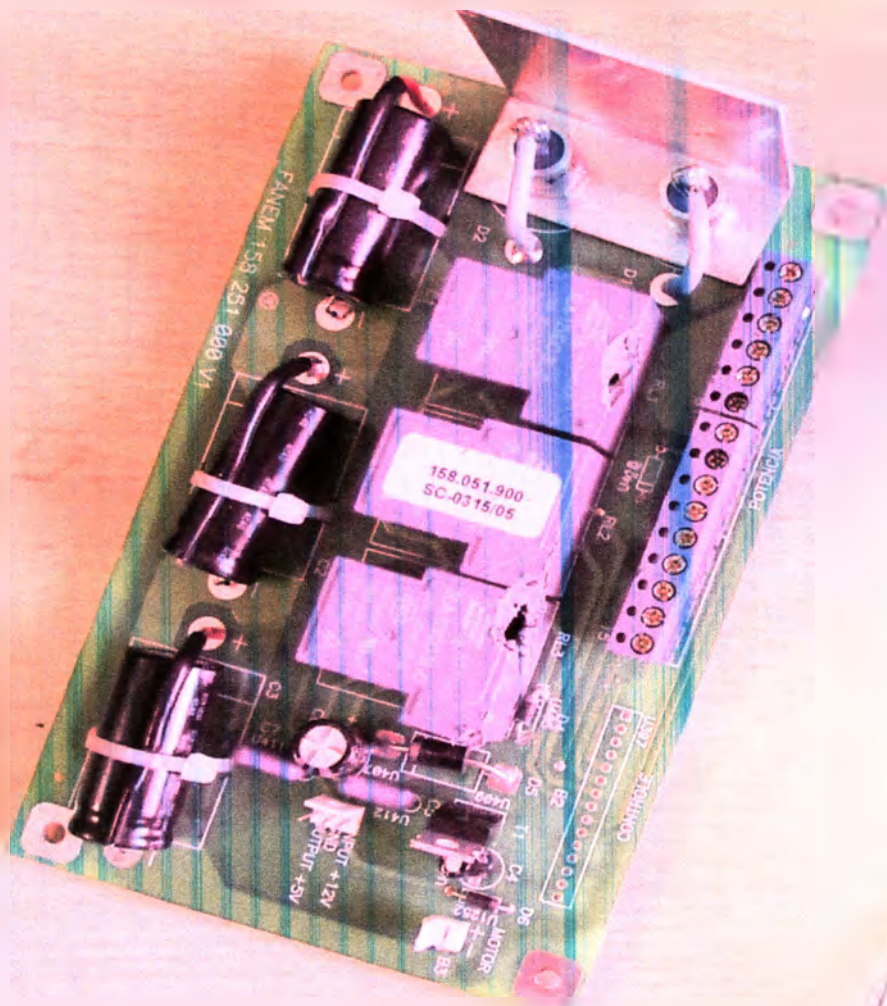


Рис.3. Увлажнитель.


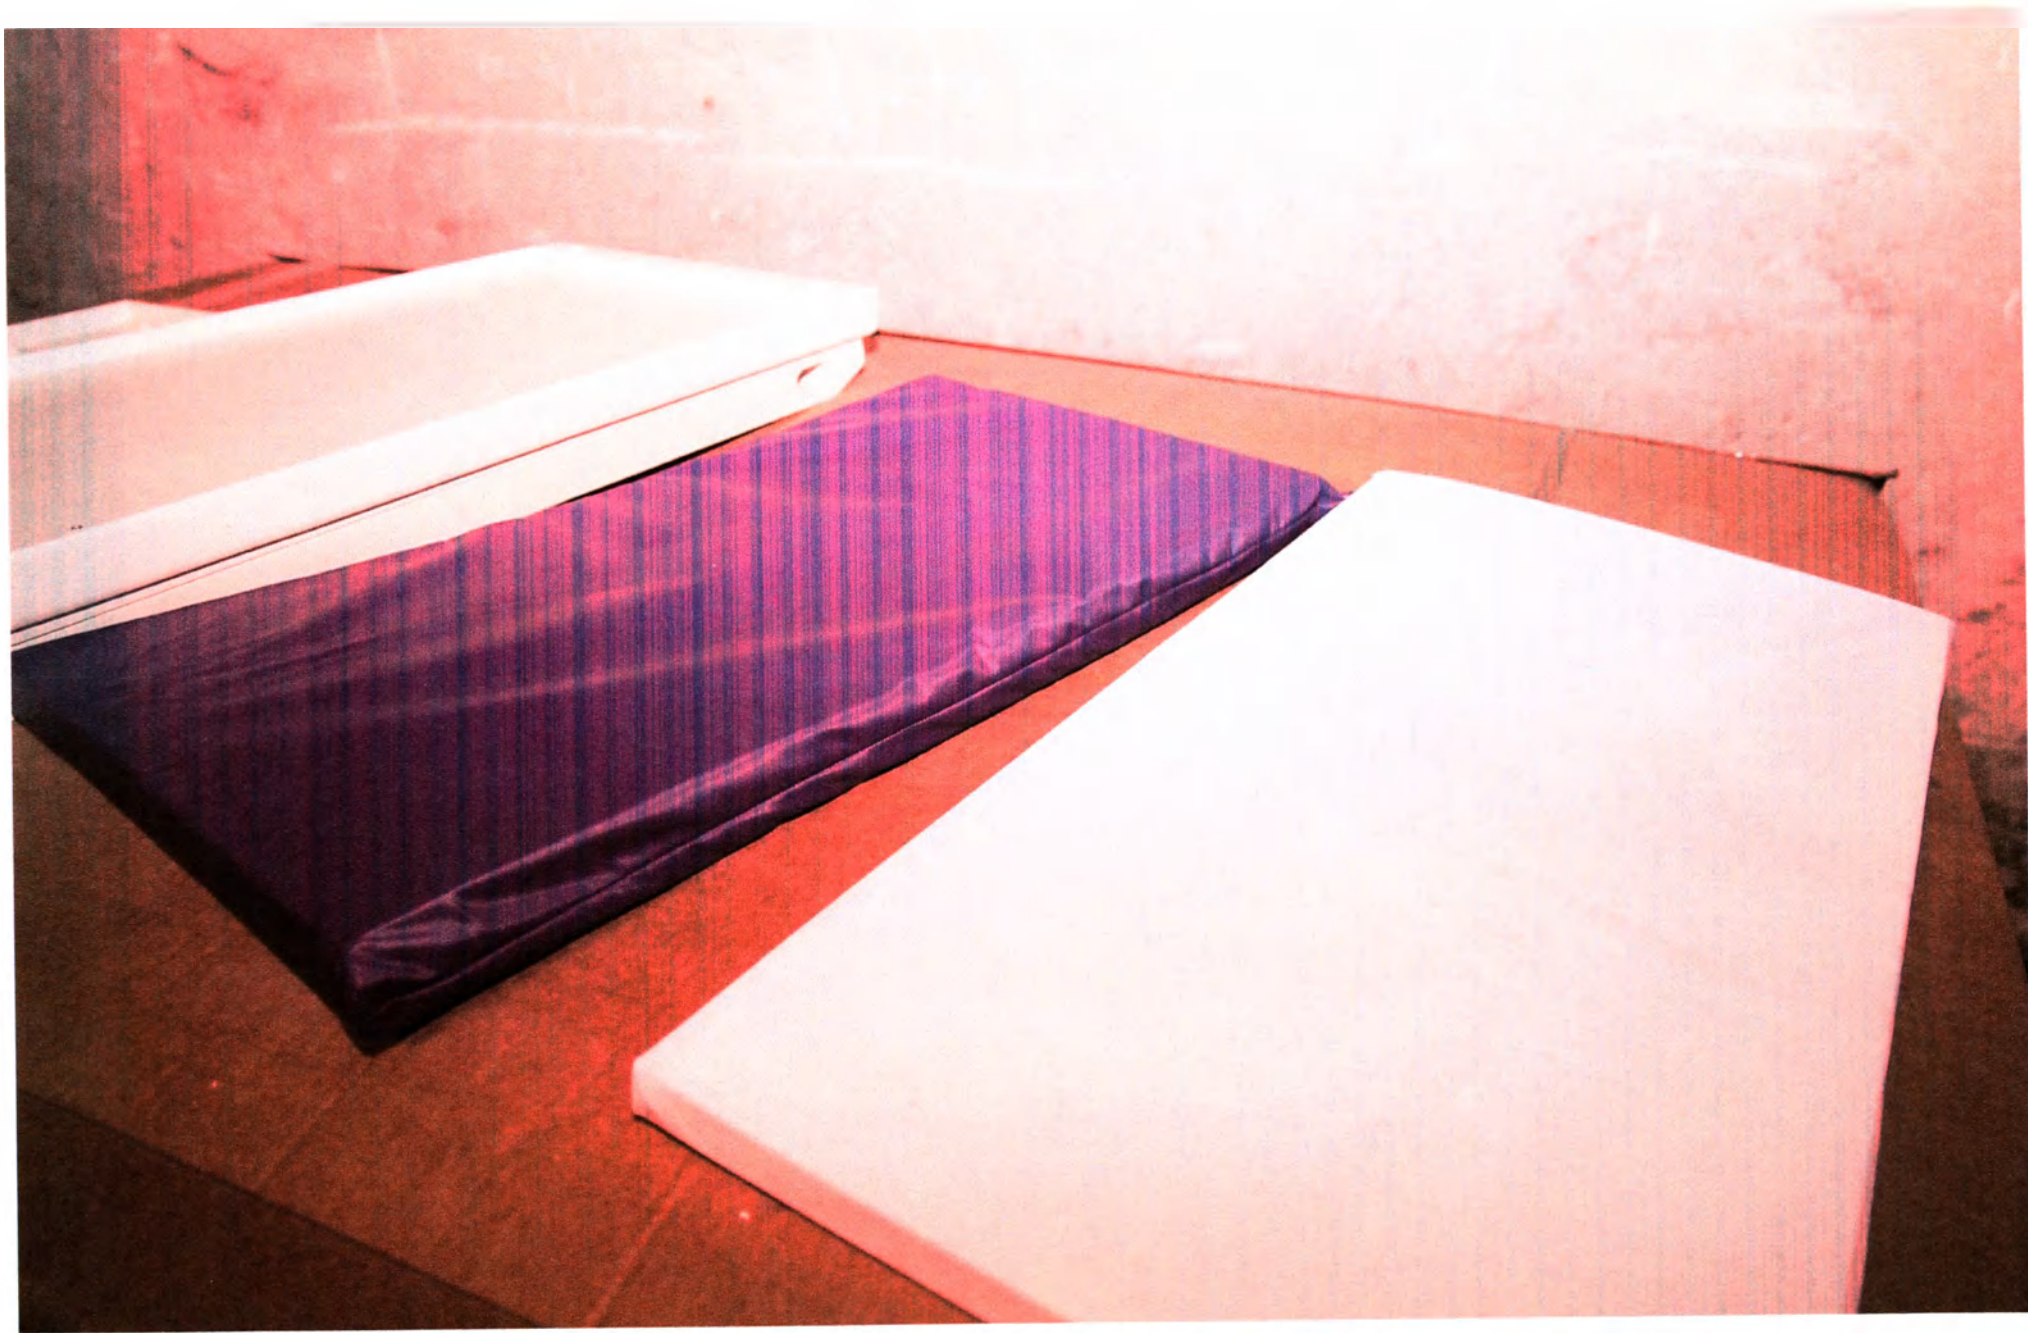


Рис. 4. Матрац (в центре)



Рис. 5. Весы неонатальные

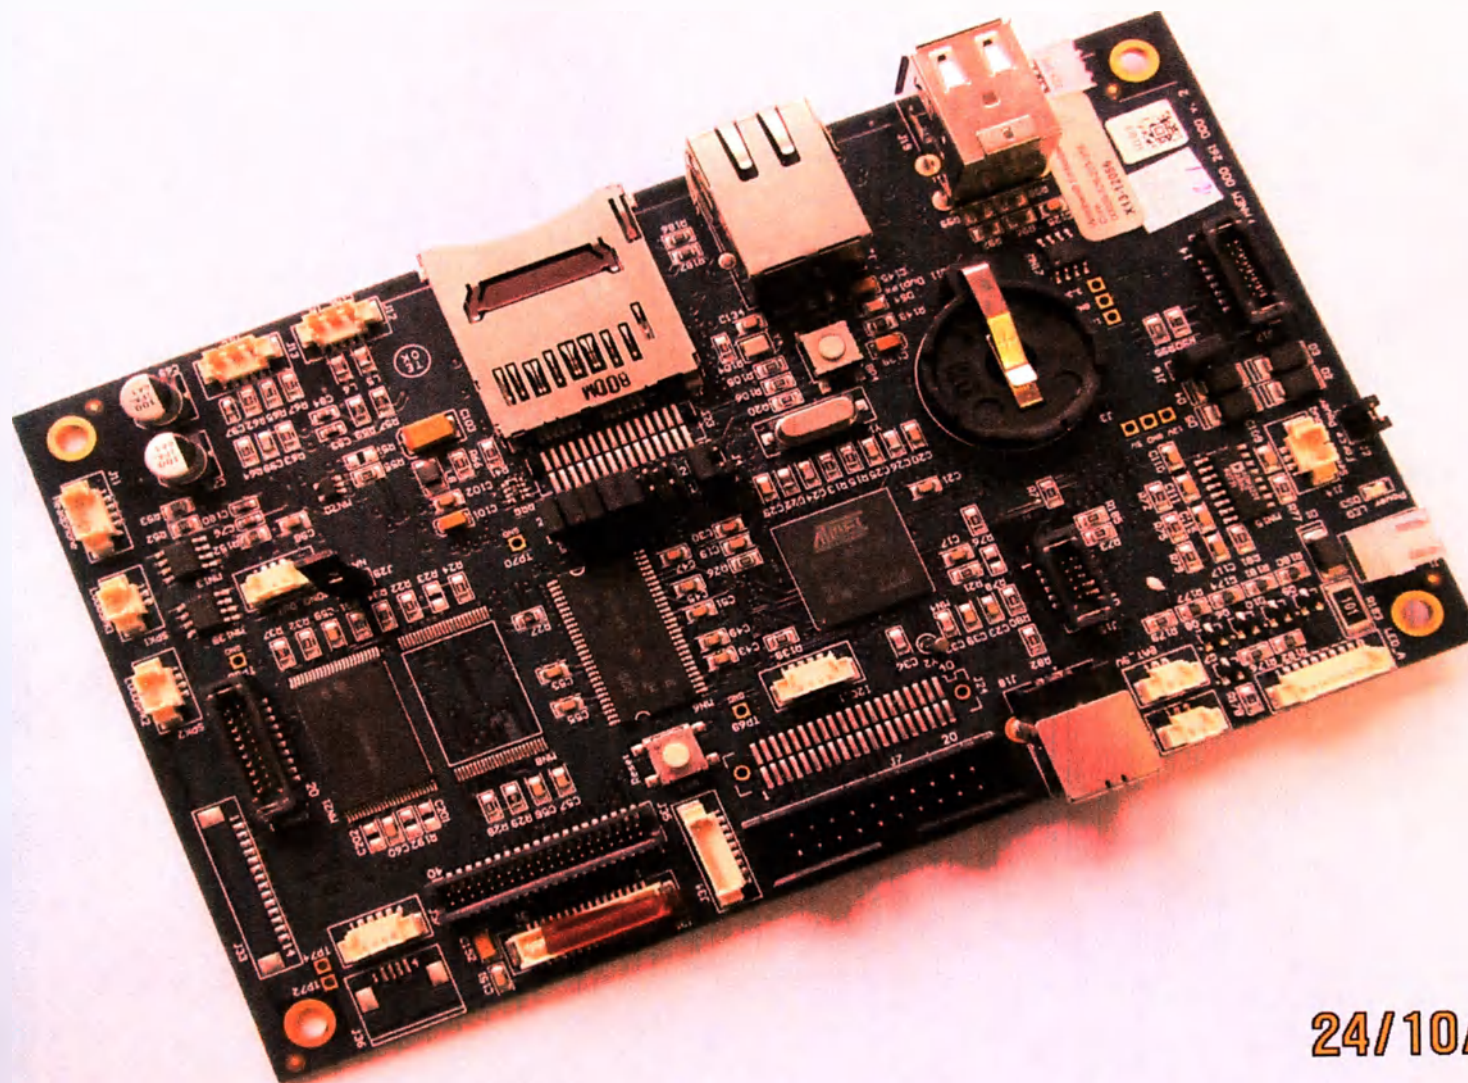

24/10/2013



Рис. 7. Датчик температуры кожи.



Рис. 8. Датчик температуры кожи периферический



Рис. 9. Датчик температуры воздуха.

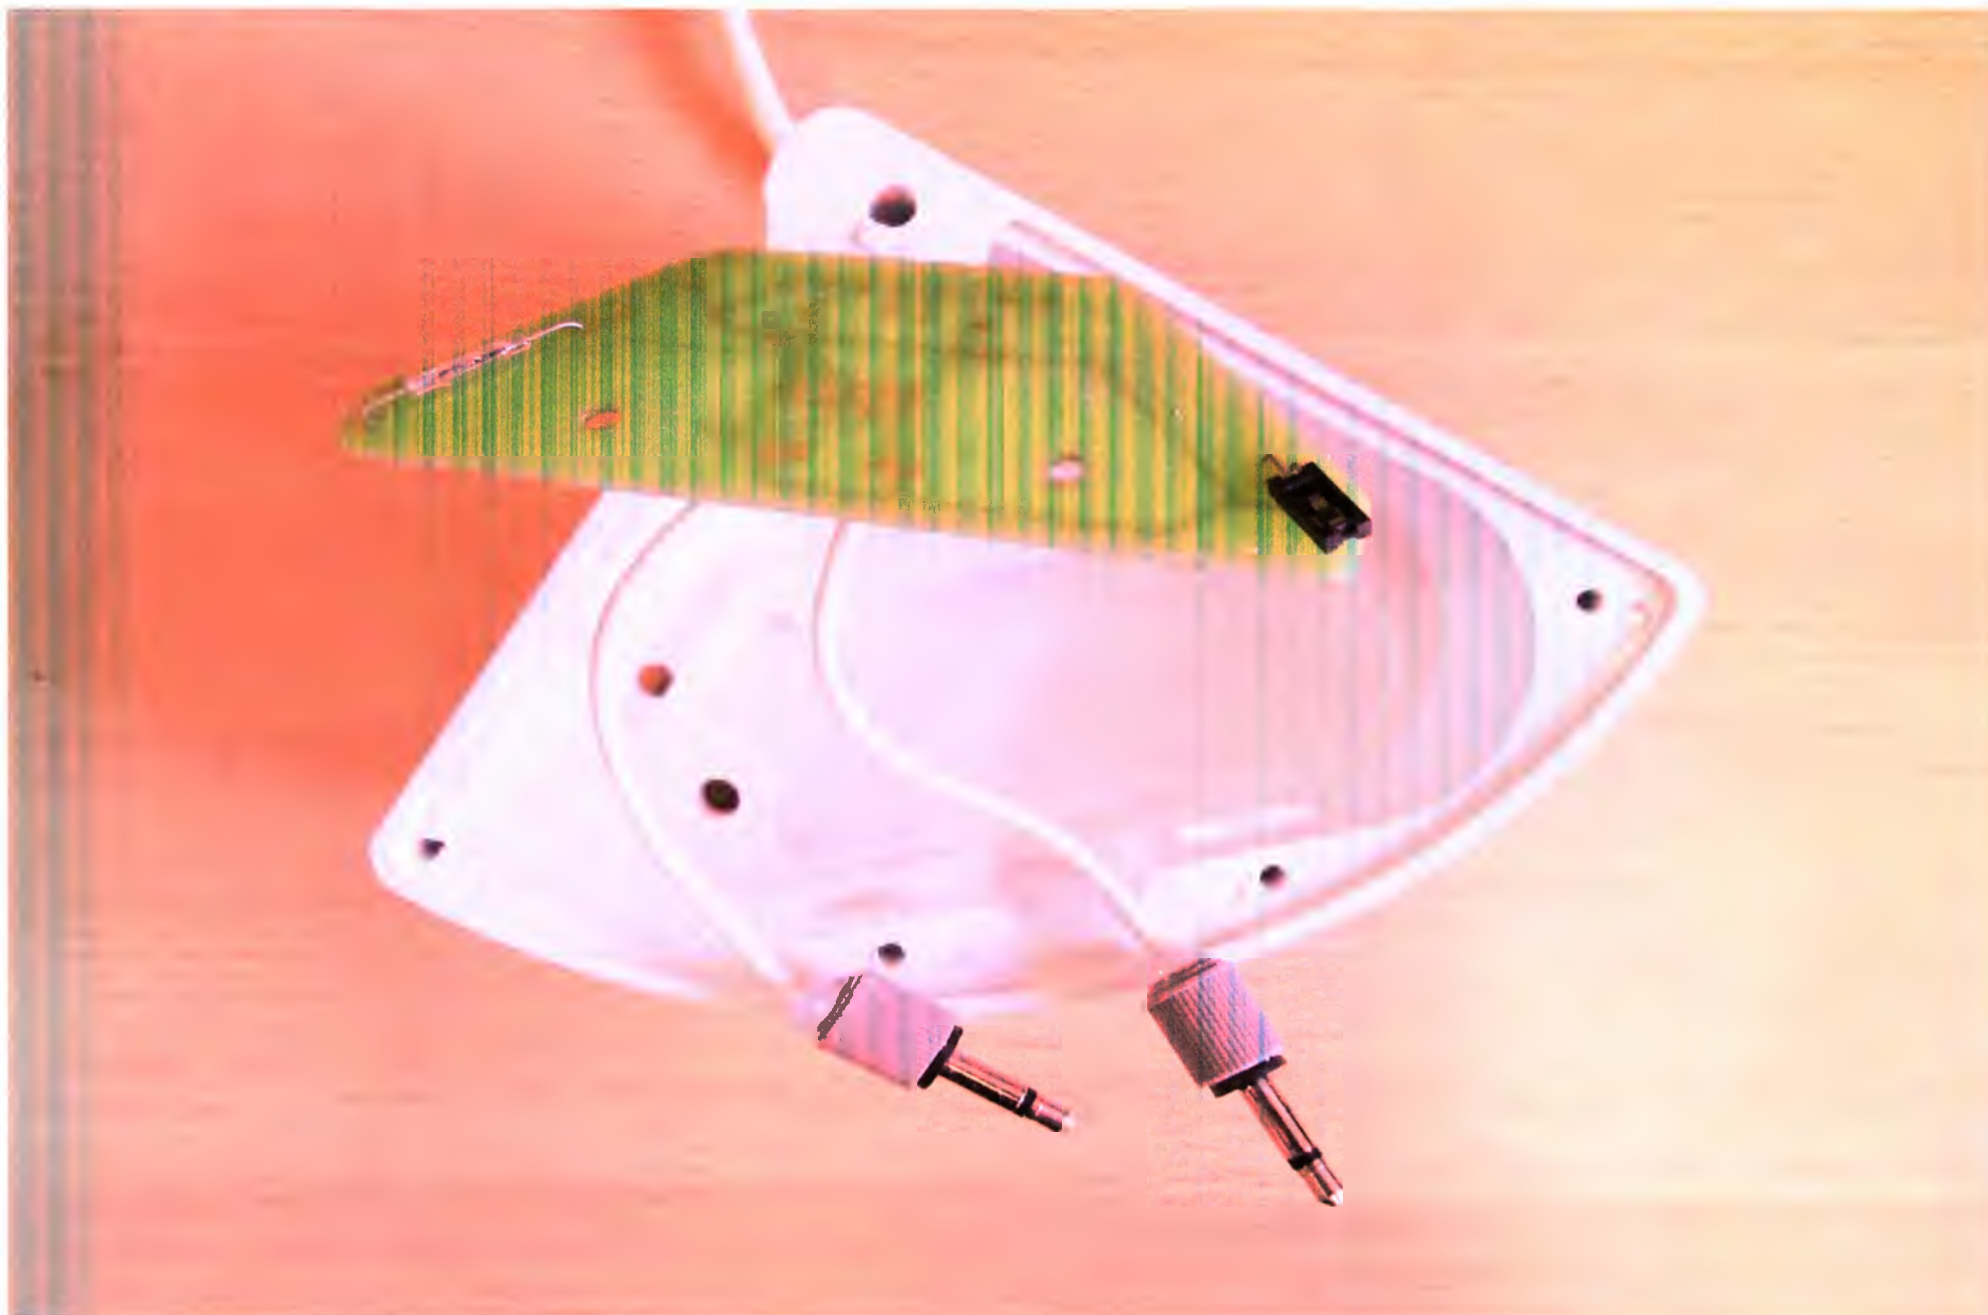


Рис. 10. Датчик влажности.



Рис. 11. Датчик концентрации кислорода.

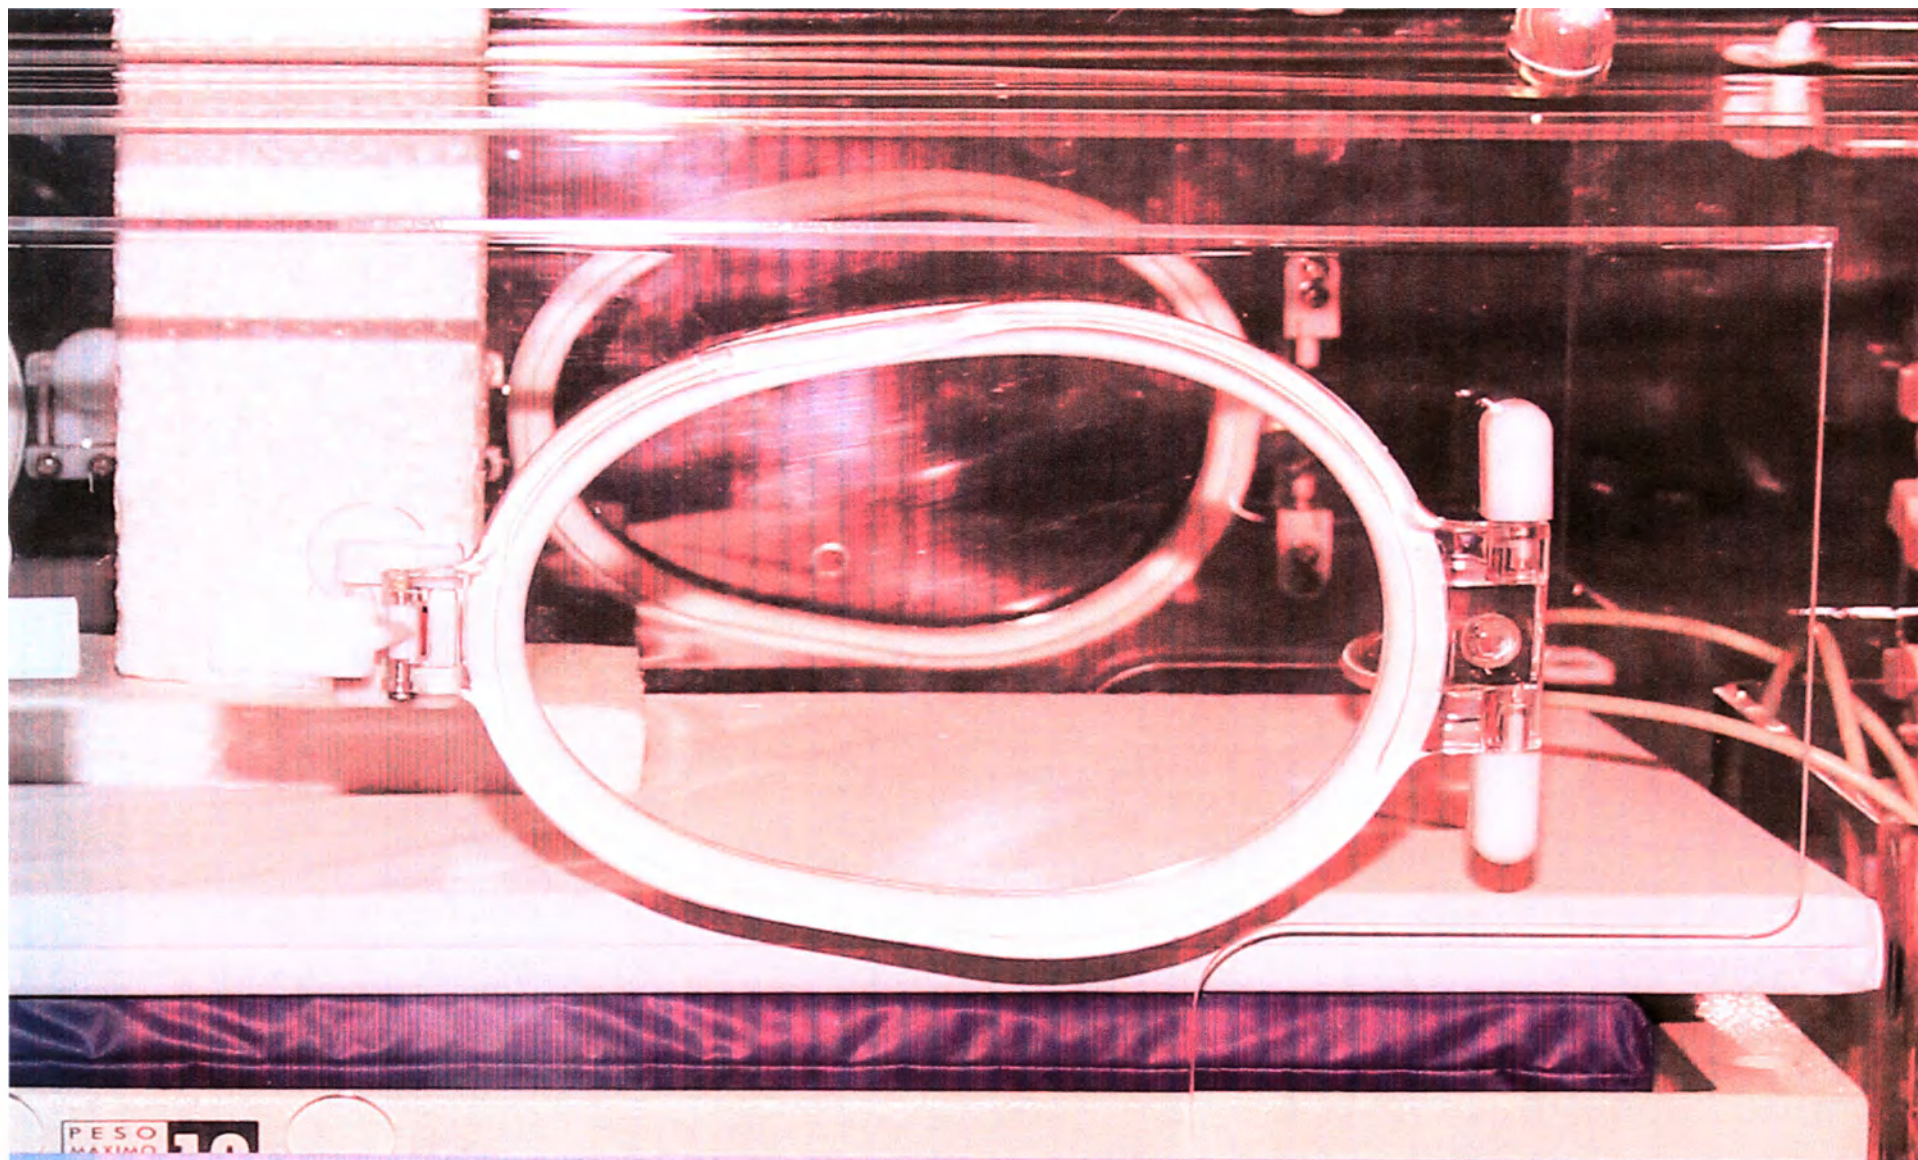


Рис. 12. Порт овальный.

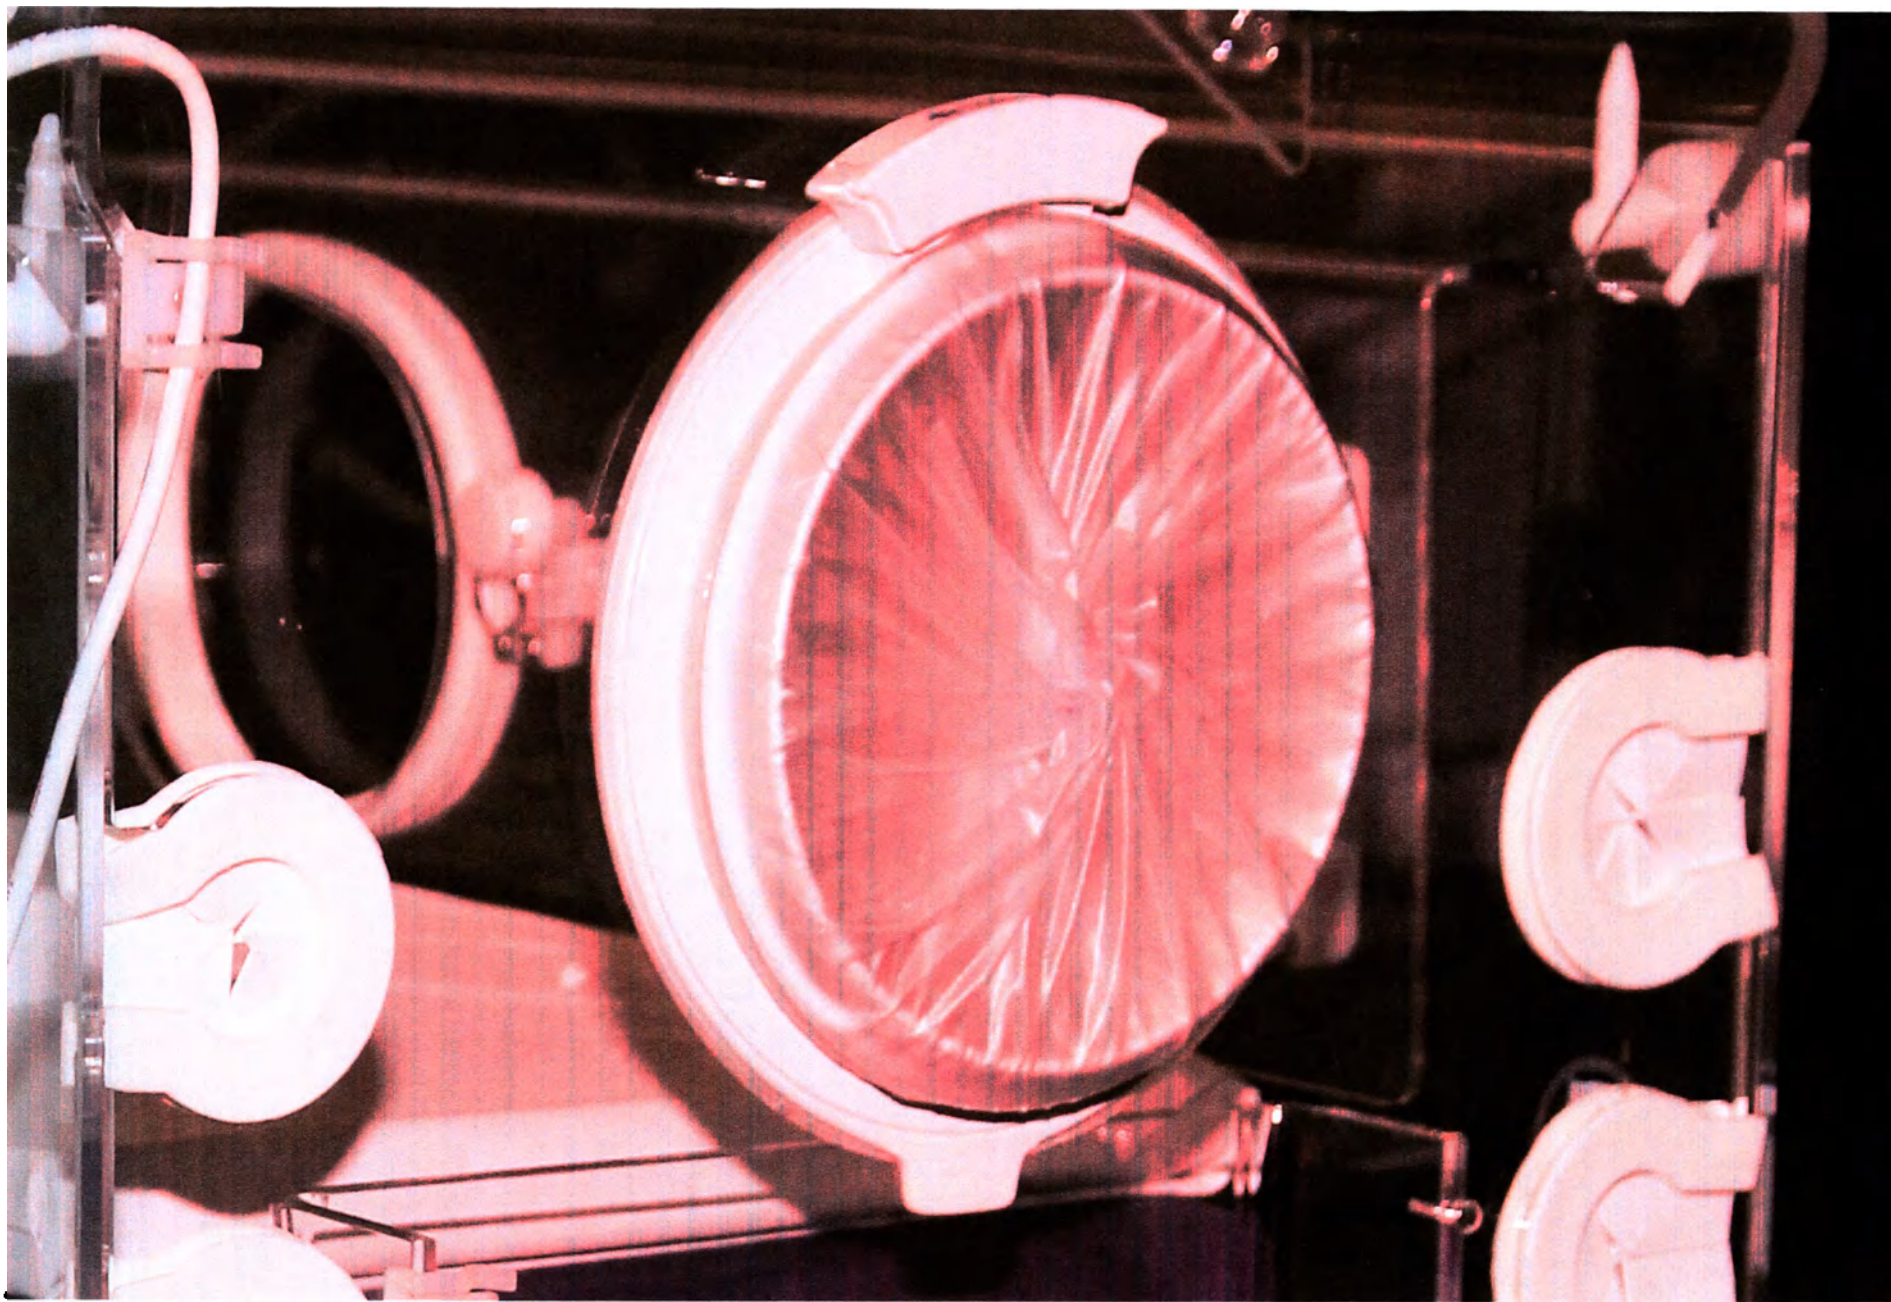


Рис. 13. Порт типа «ирис».

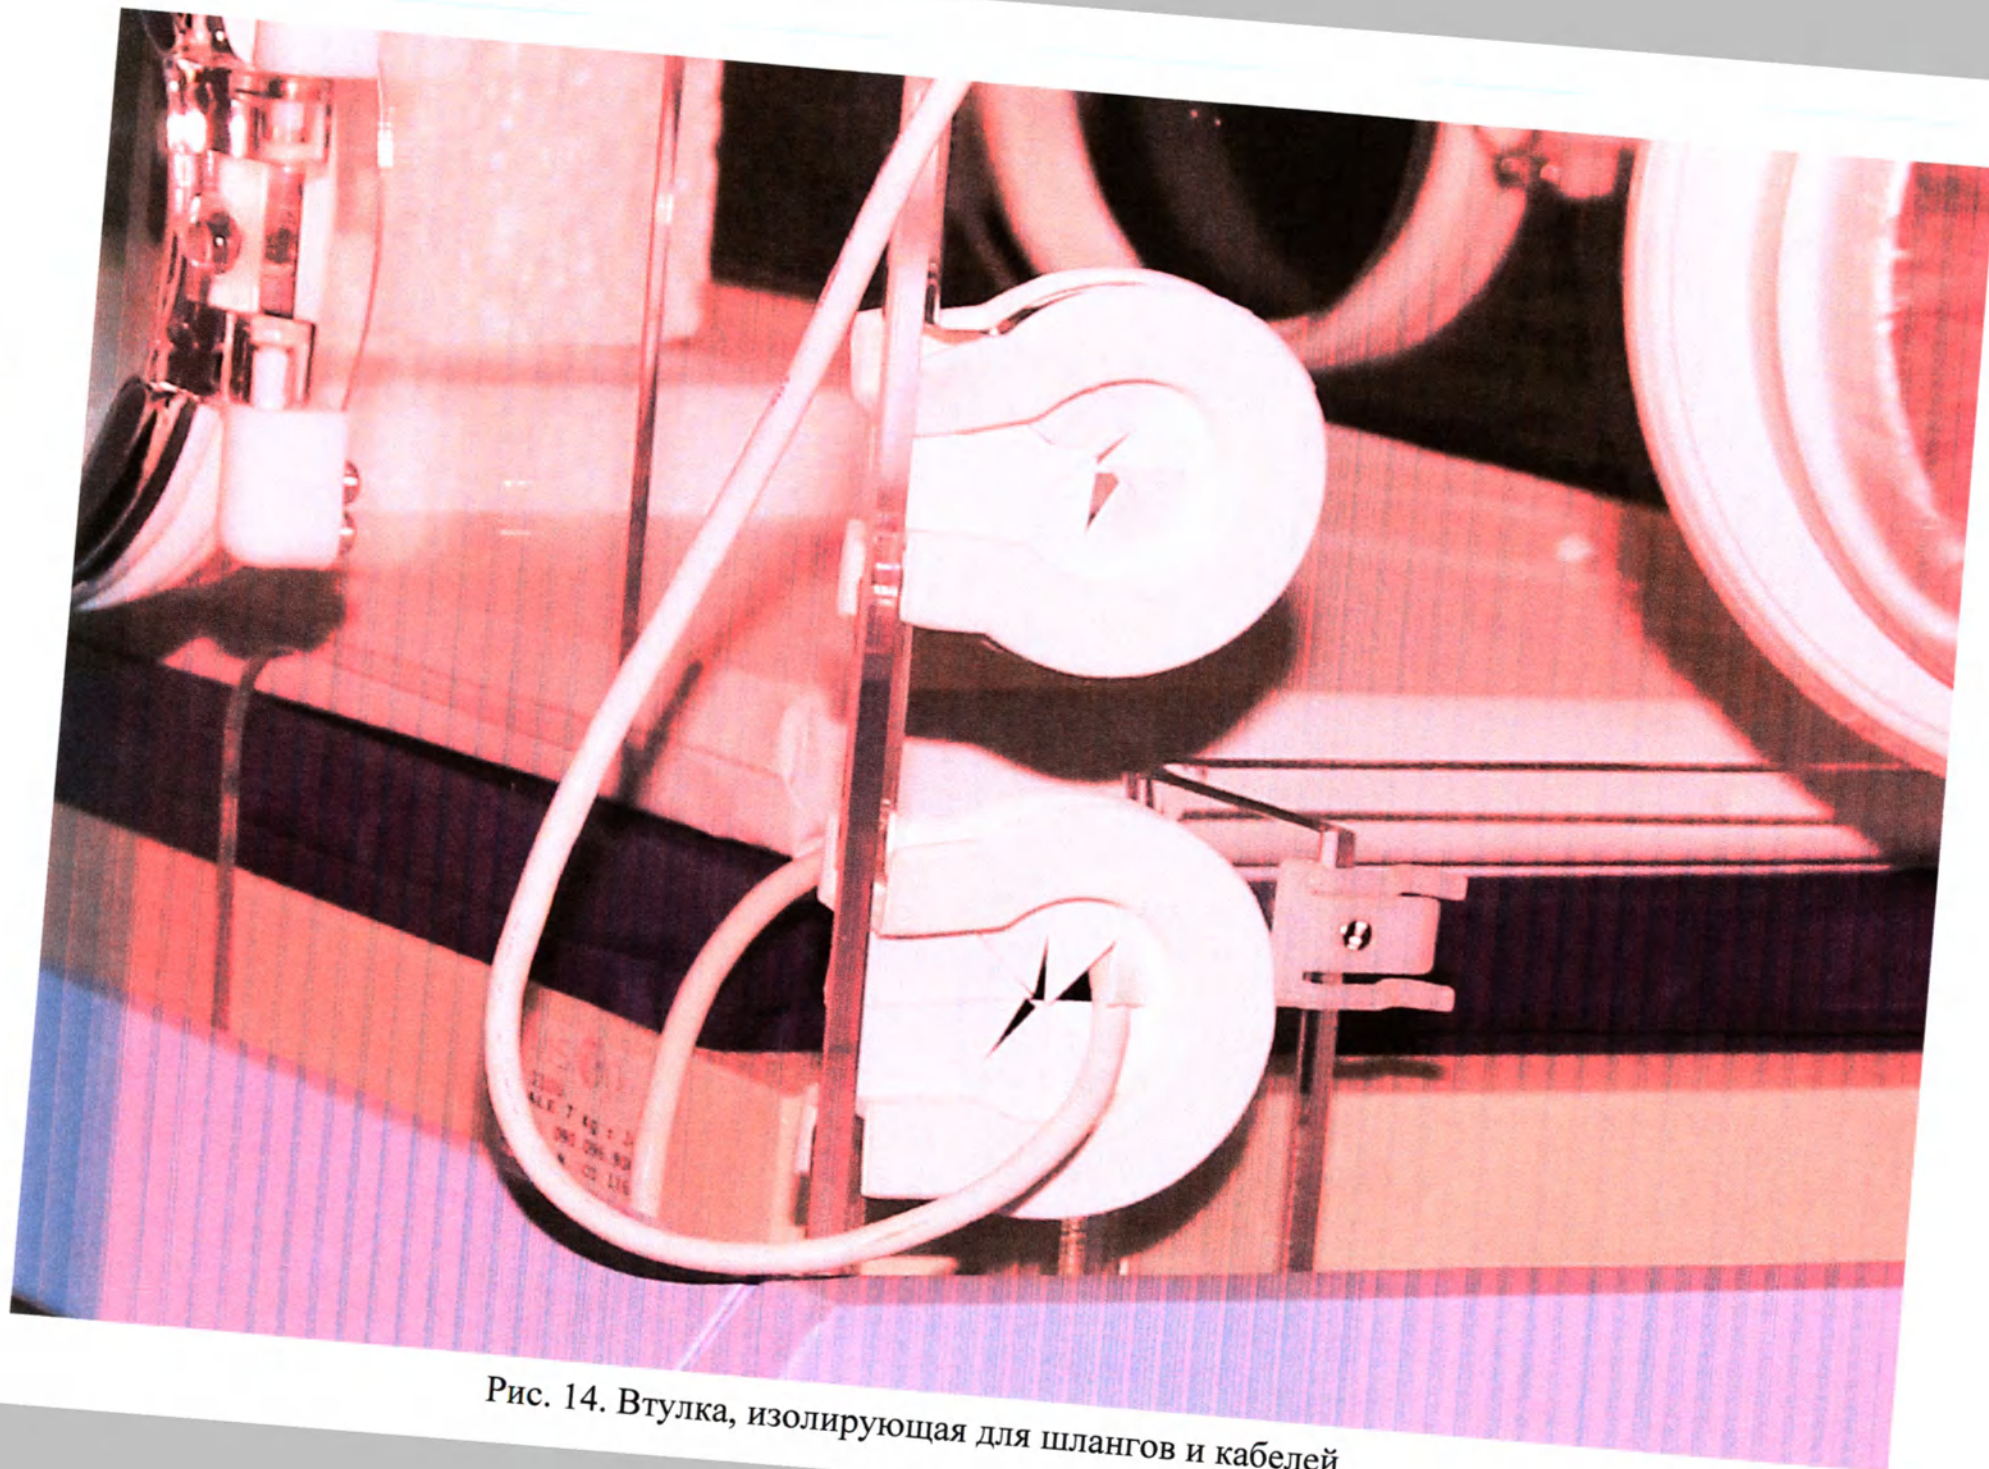


Рис. 14. Втулка, изолирующая для шлангов и кабелей.



Рис. 15. Стойка вертикальная для в/в инфузий.



Рис. 16. Ящик выдвижной; ящик с дверцей.



Рис. 17. Полка поворотная.

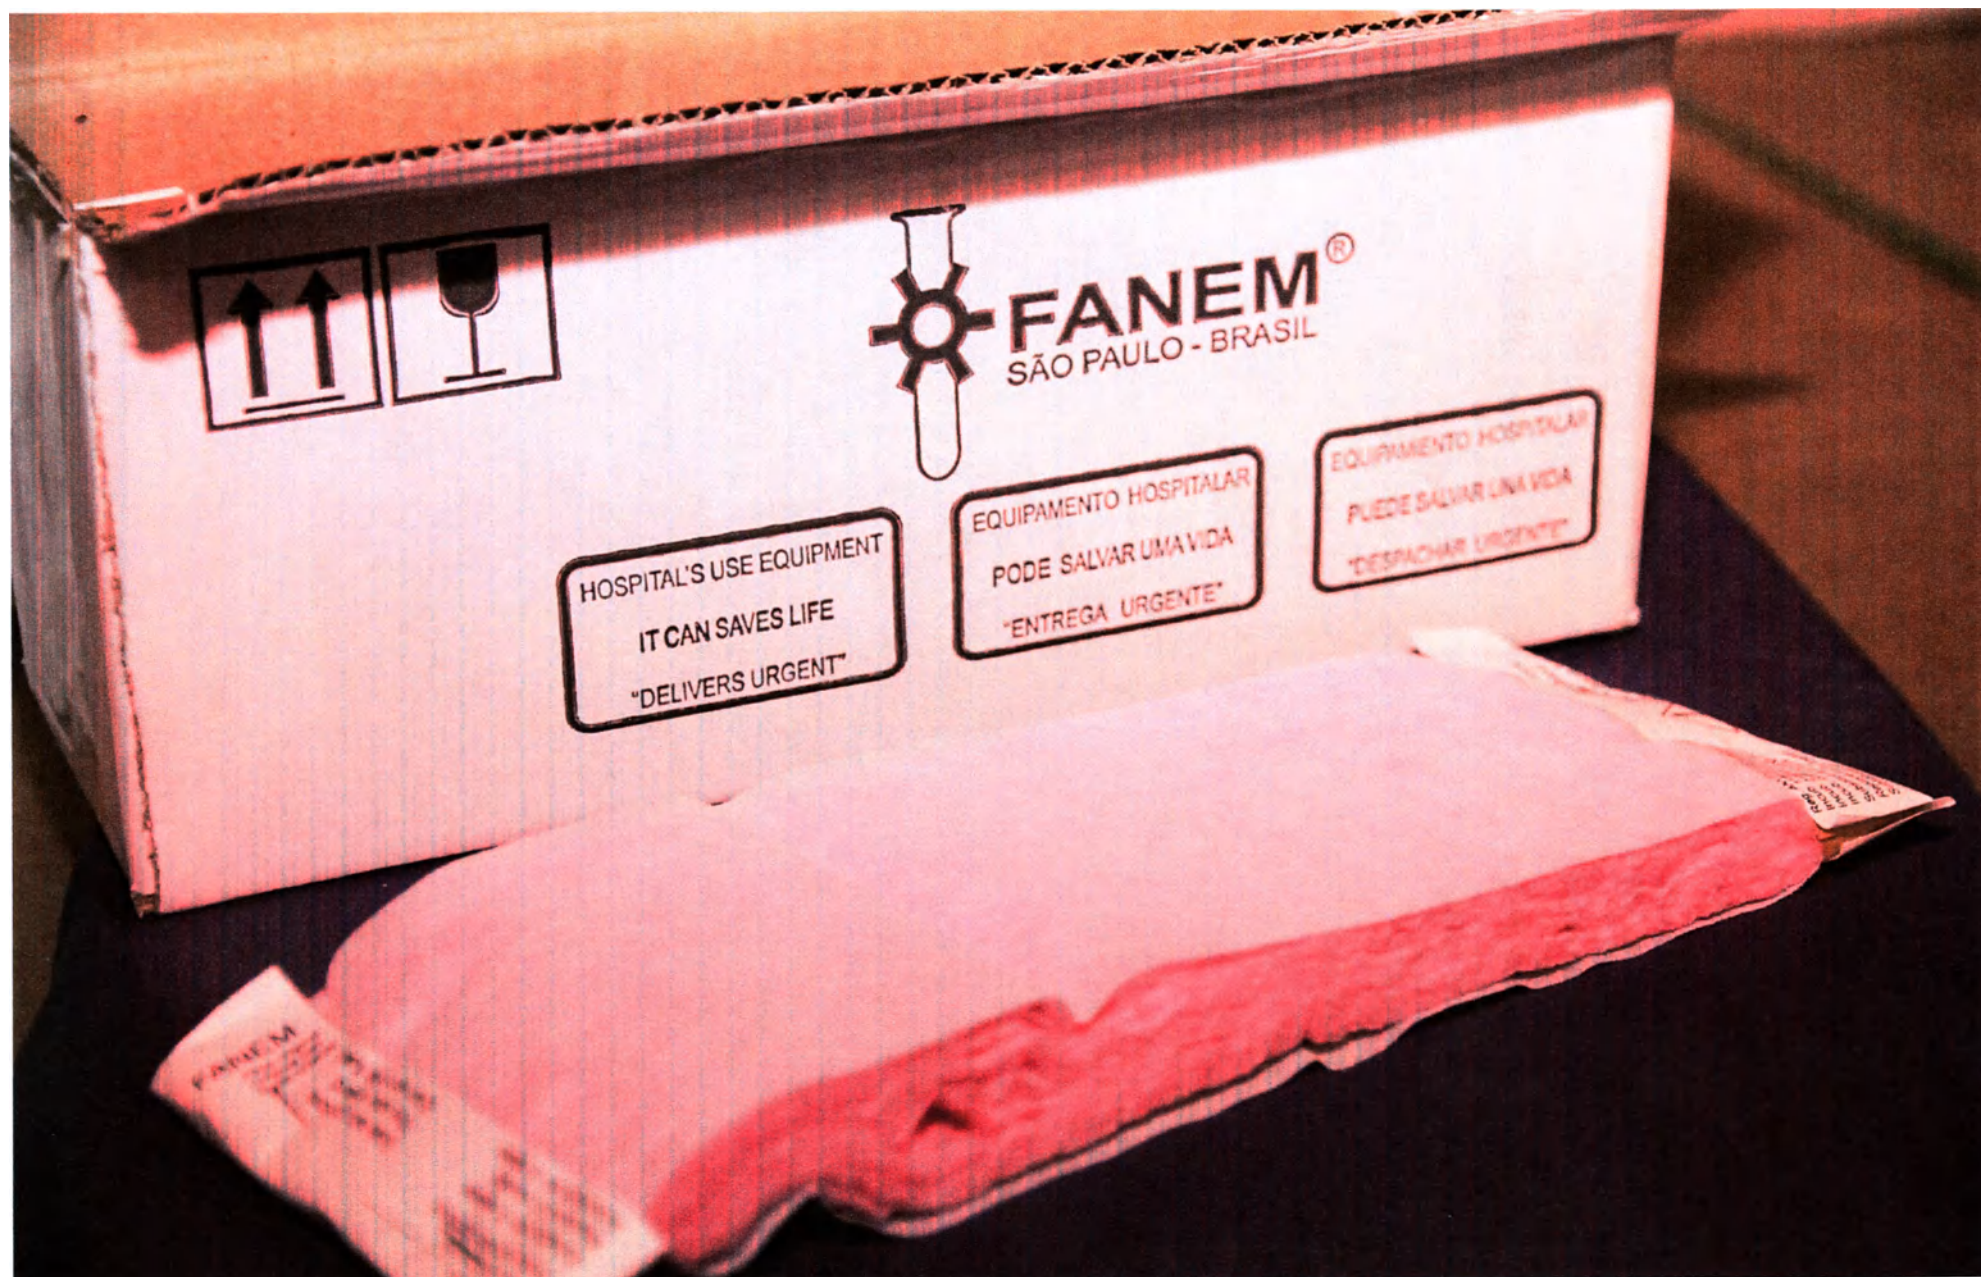


Рис. 18. Фильтр воздушный.







Рис. 21. Рукав порта типа «ирис».



Рис. 22. Резервуар увлажнителя.

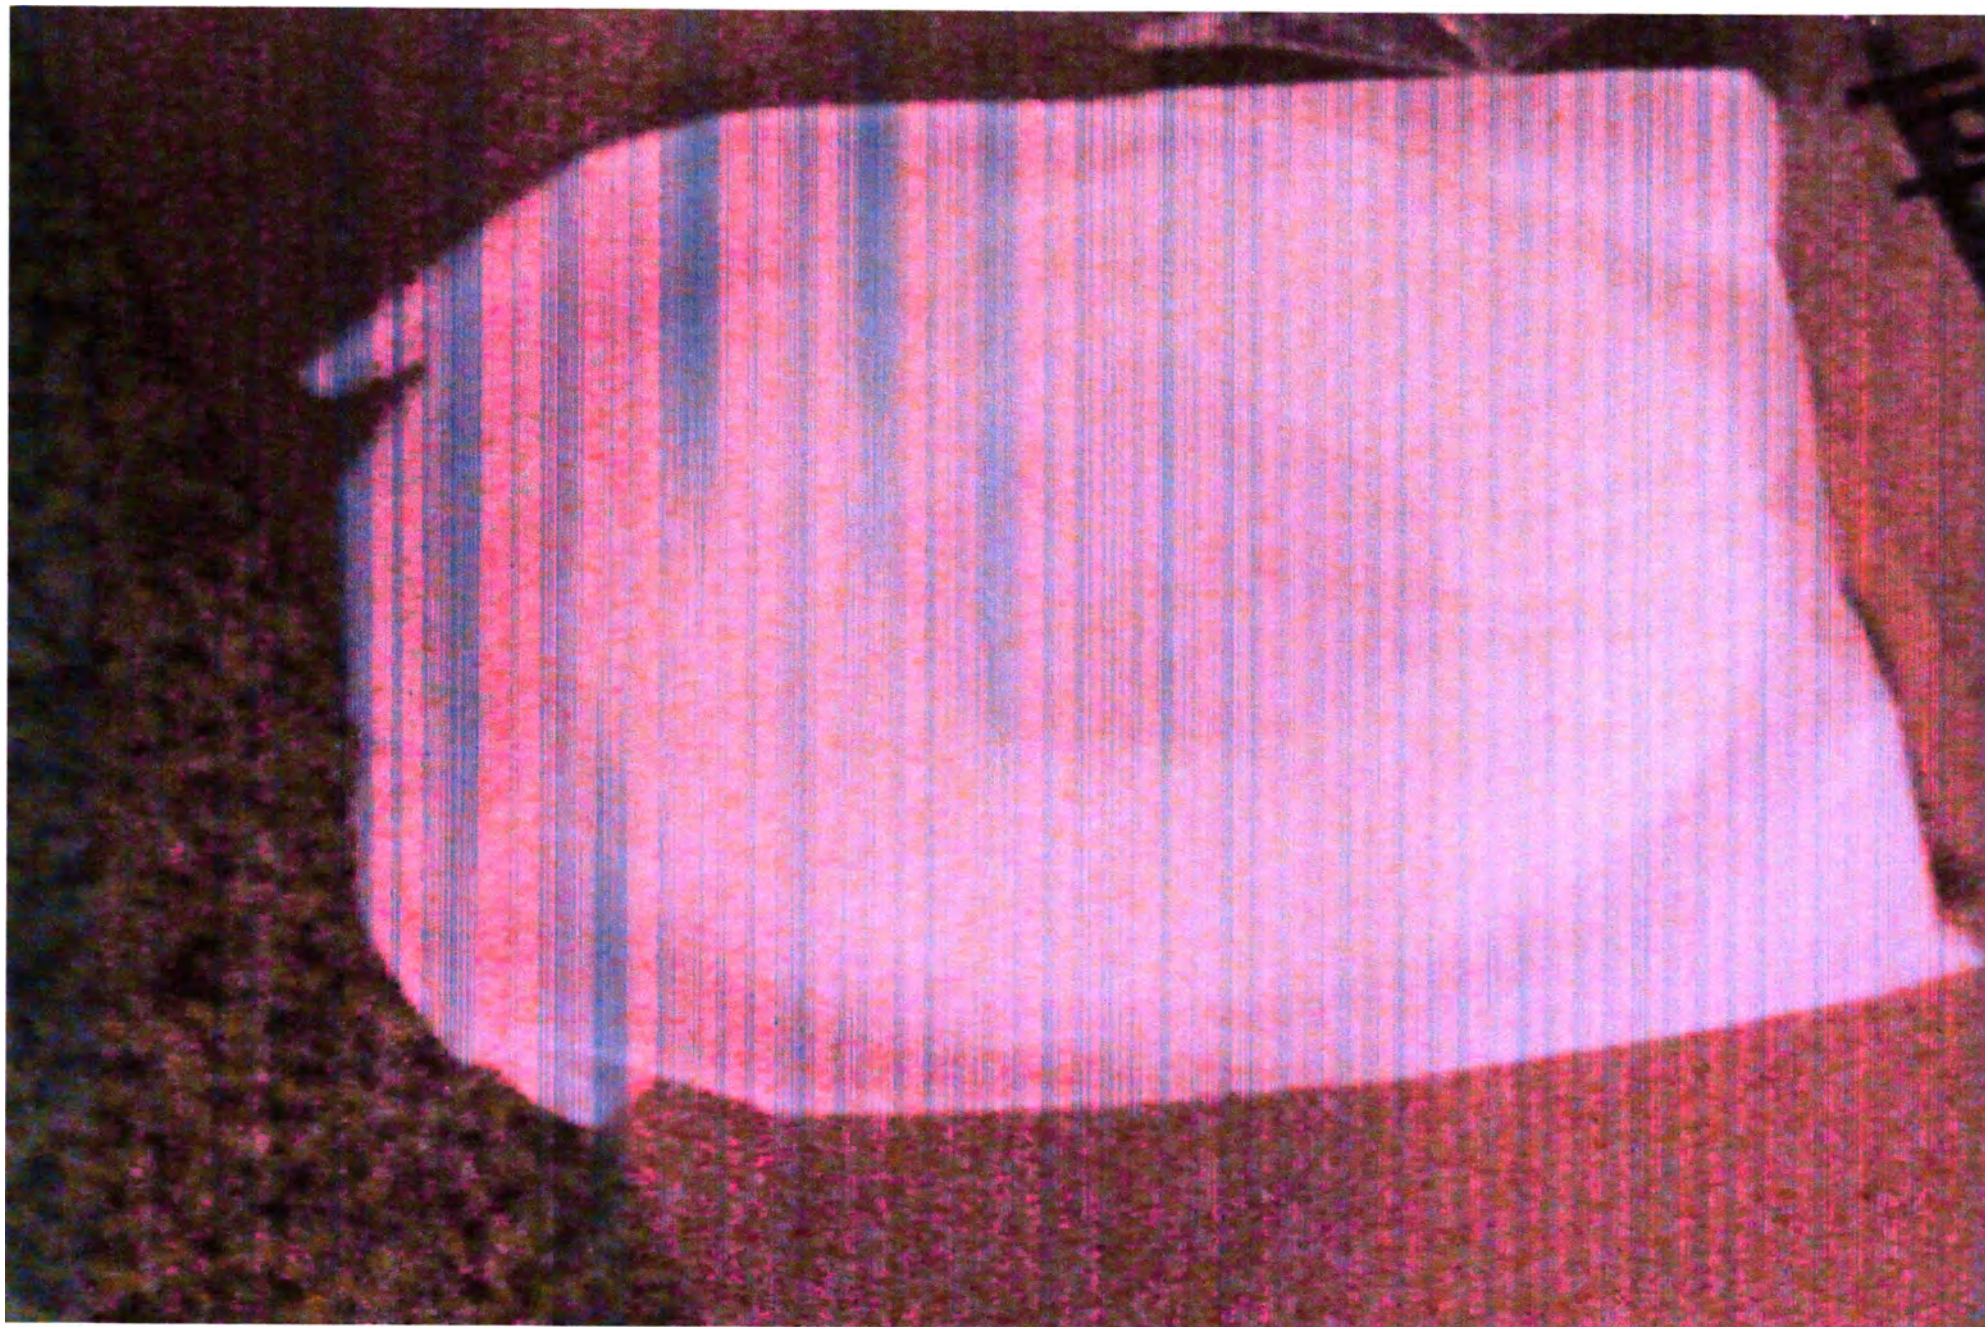


Рис. 23. Подушка неонатальная для фиксации головы.



Рис. 24. Шлем акриловый с кислородным клапаном.



Рис. 25. Пульсоксиметр неонатальный с кабелем.

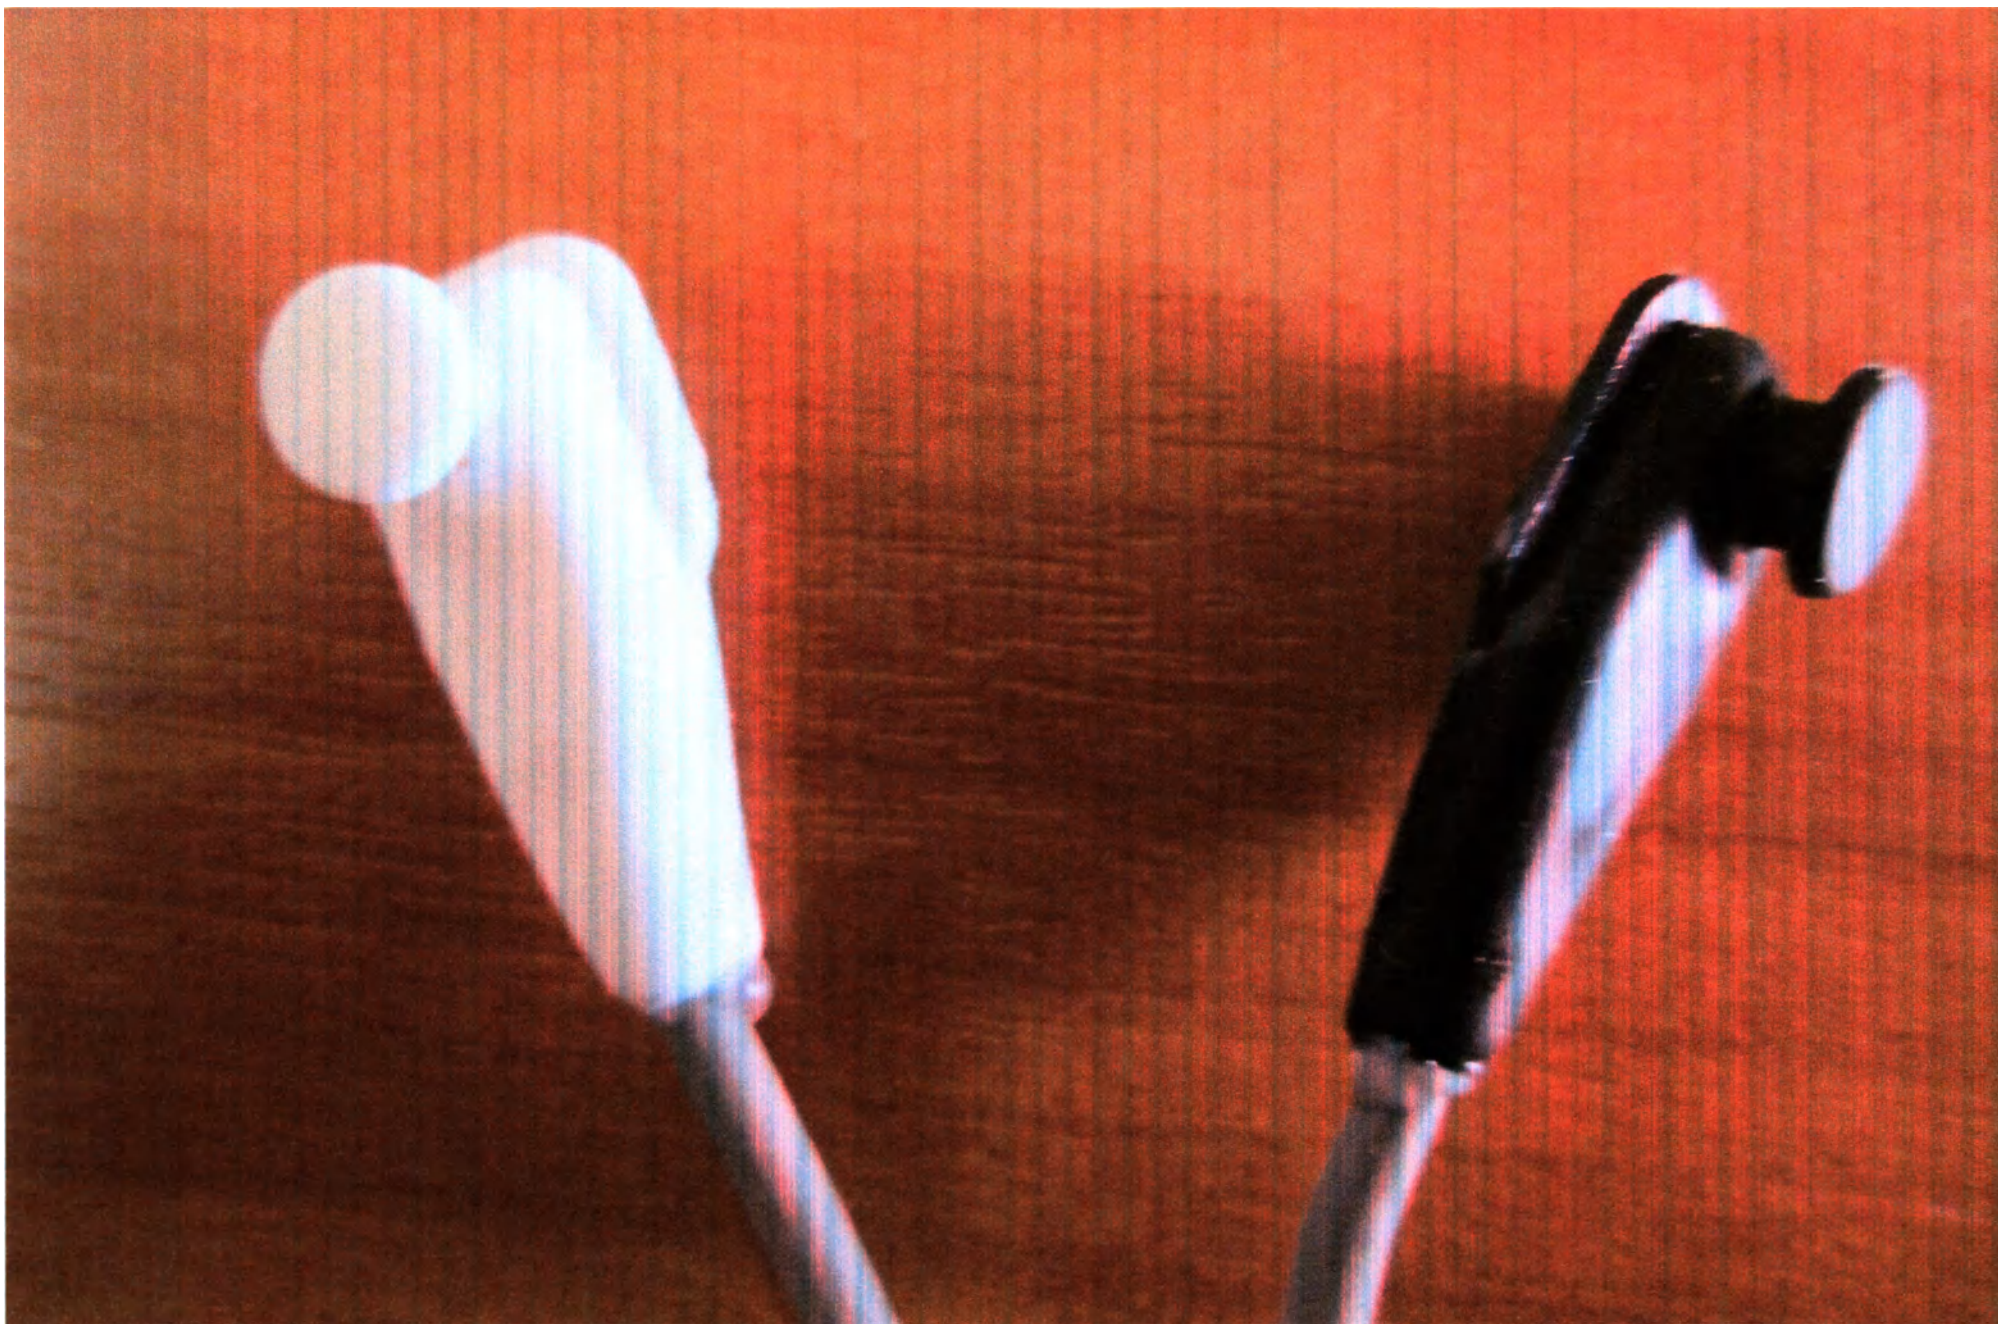


Рис. 26. Датчик пульсоксиметра неонатального.

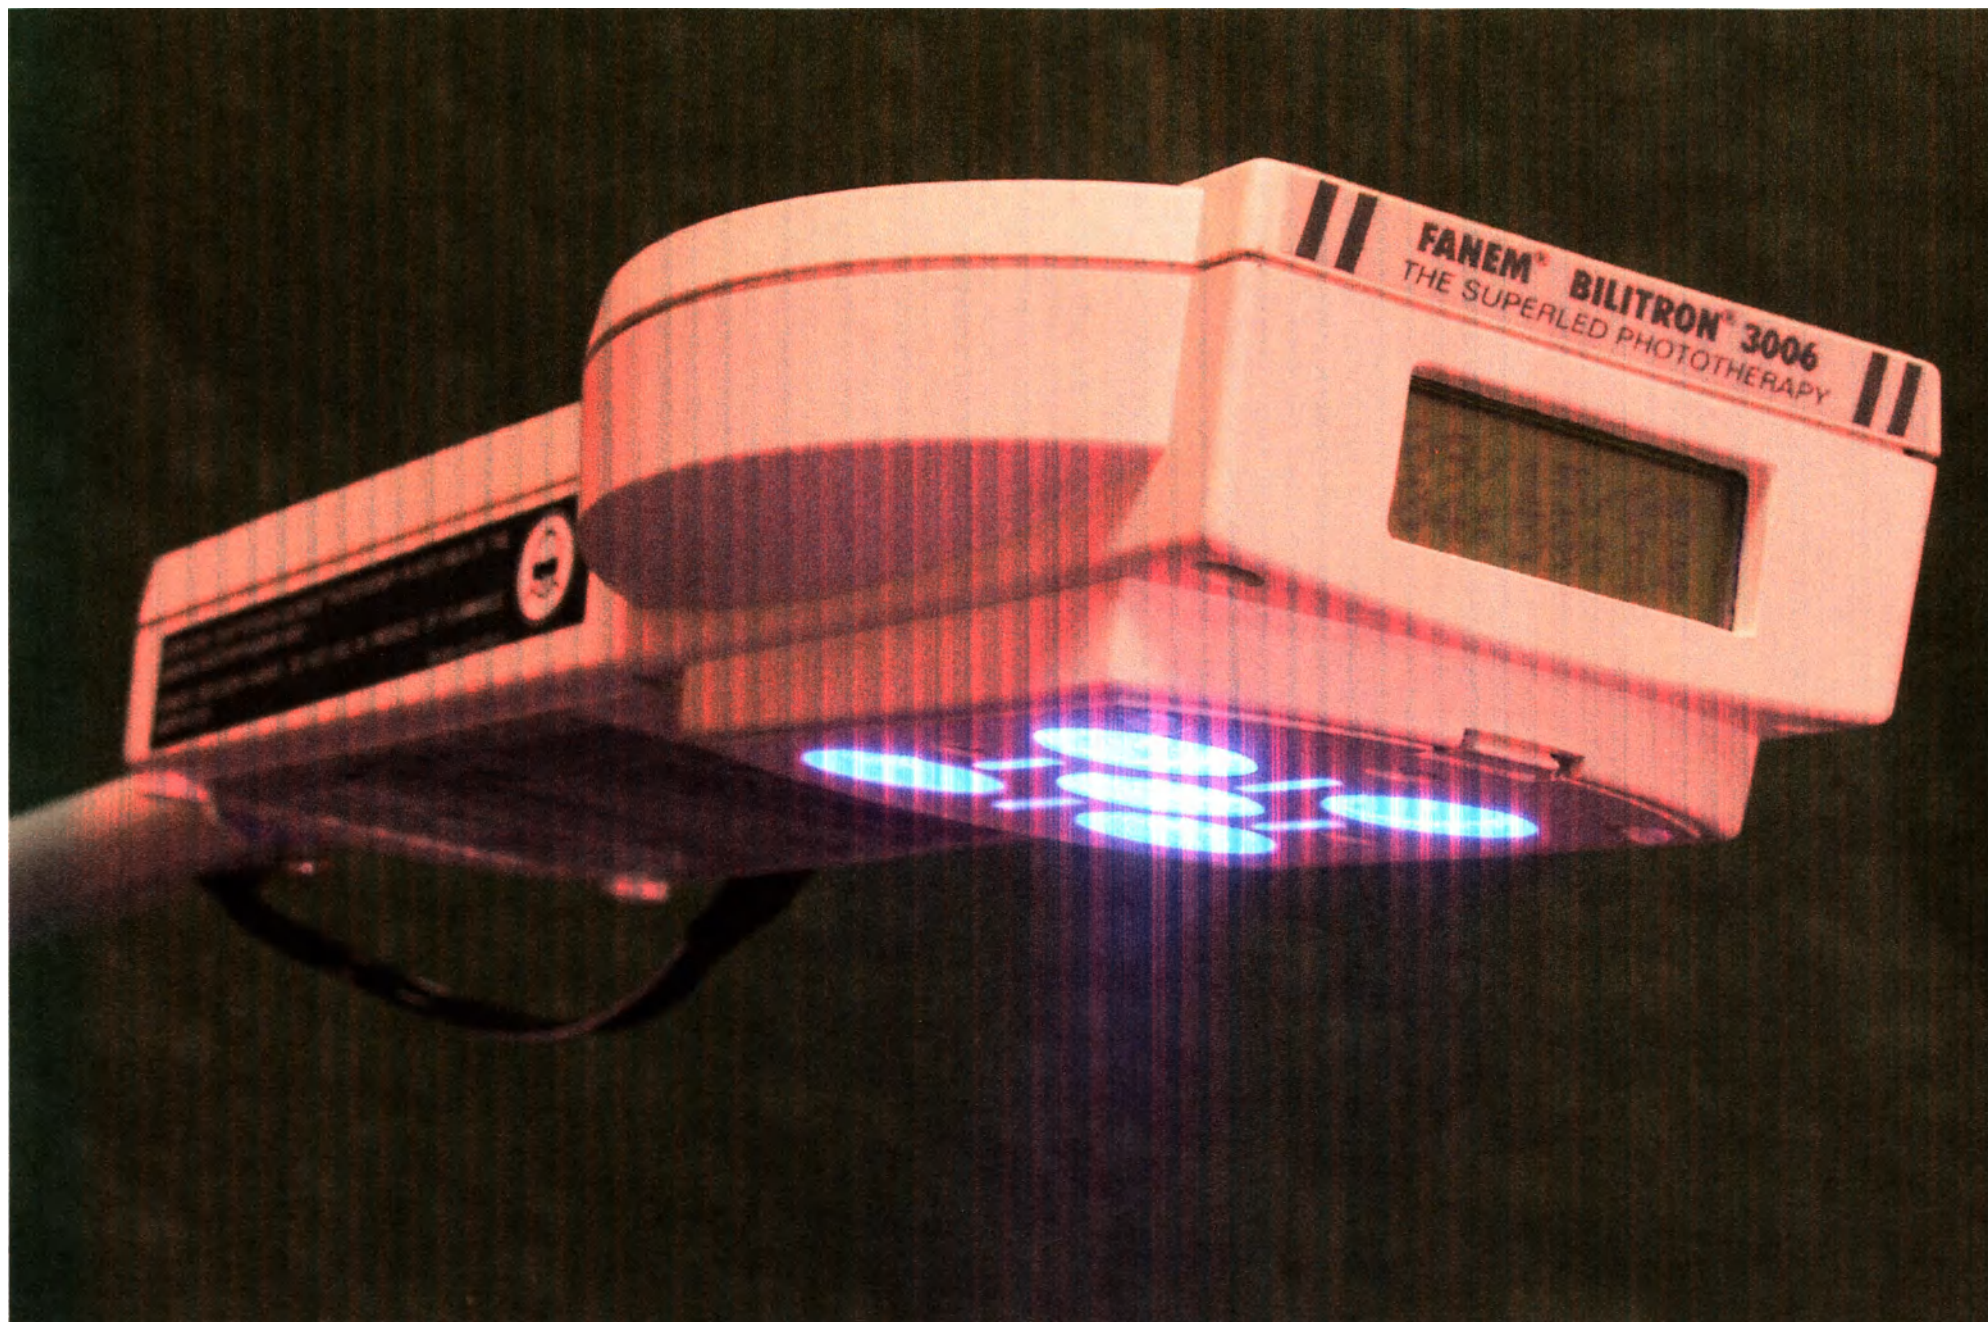


Рис. 27. Лампа фототерапии с креплением на инкубатор.

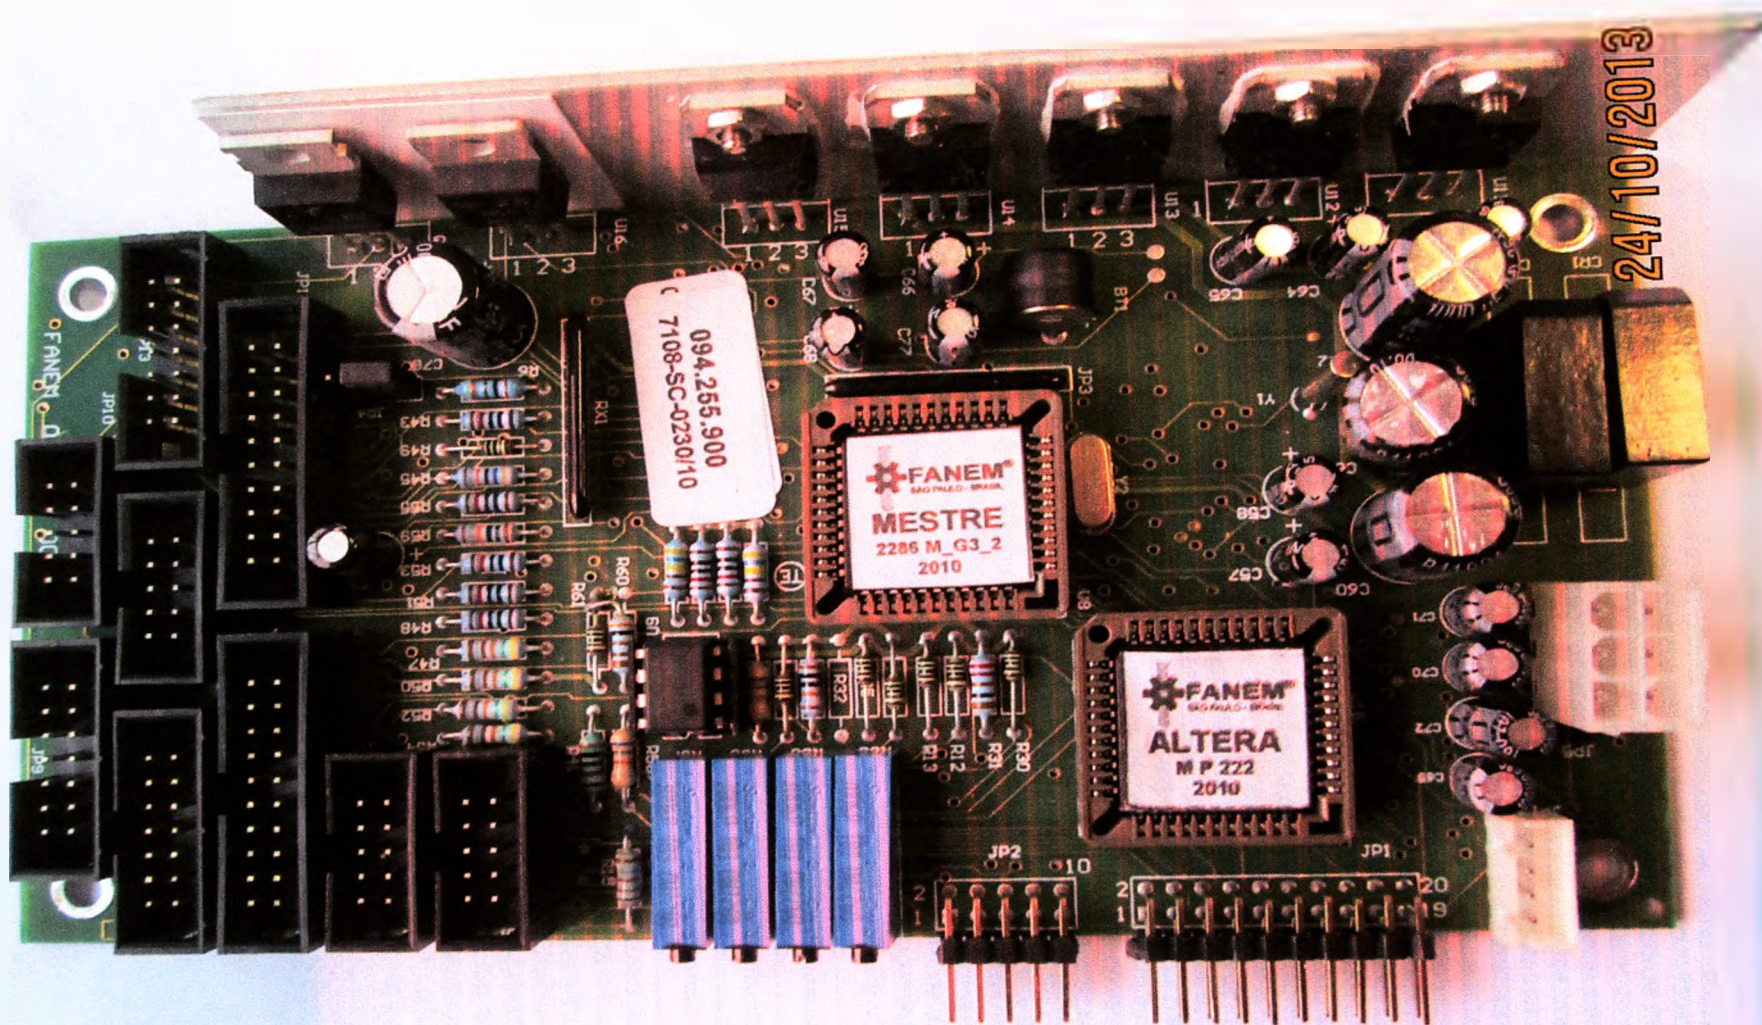


Рис. 28. Плата съемная электронная управления узлами инкубатора.



Рис. 29. Блок съемный электронный контролирующий для инкубатора.

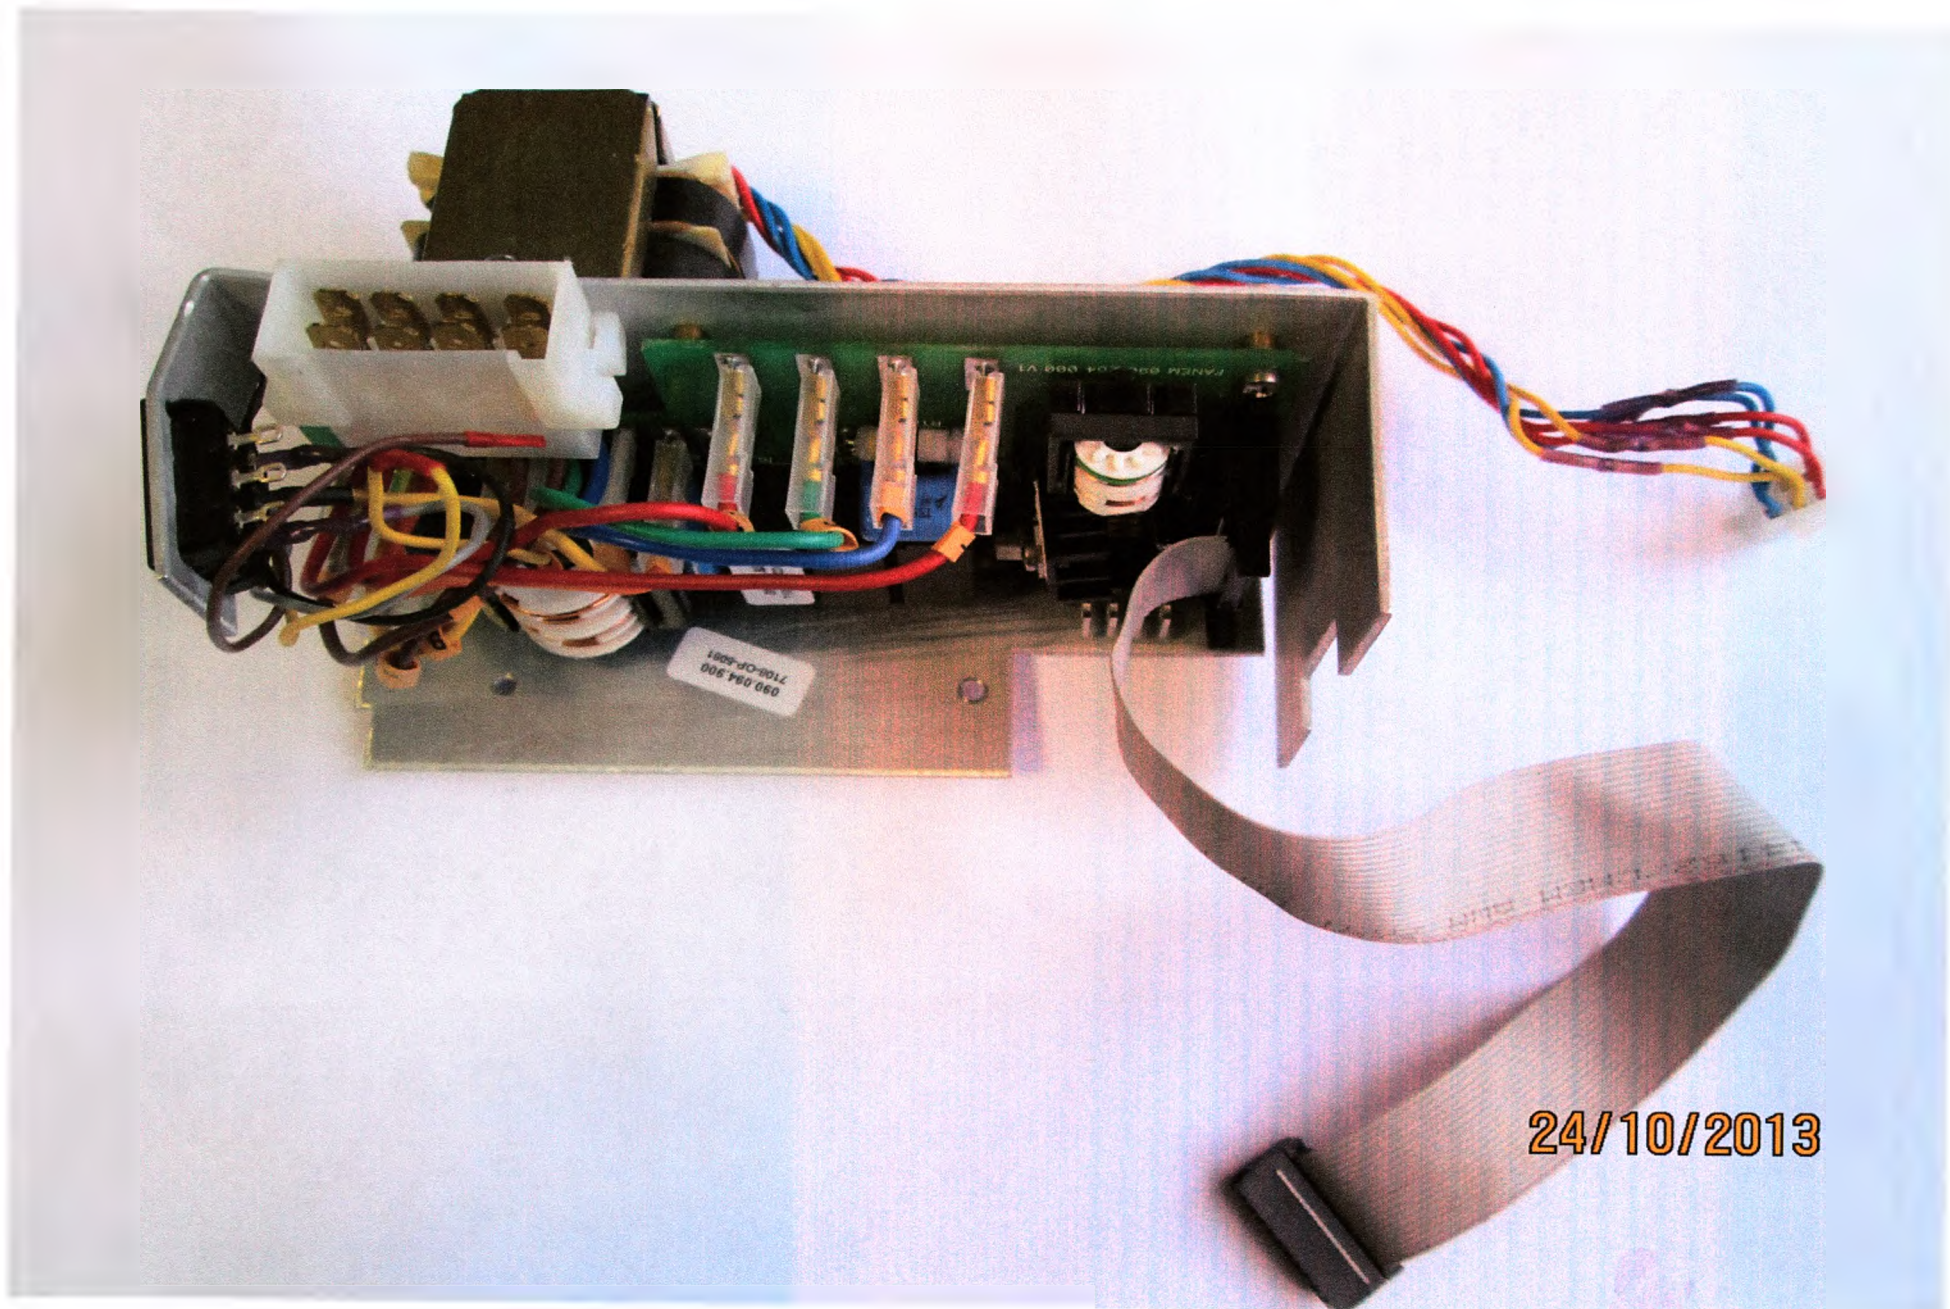


Рис. 30. Блок питания.

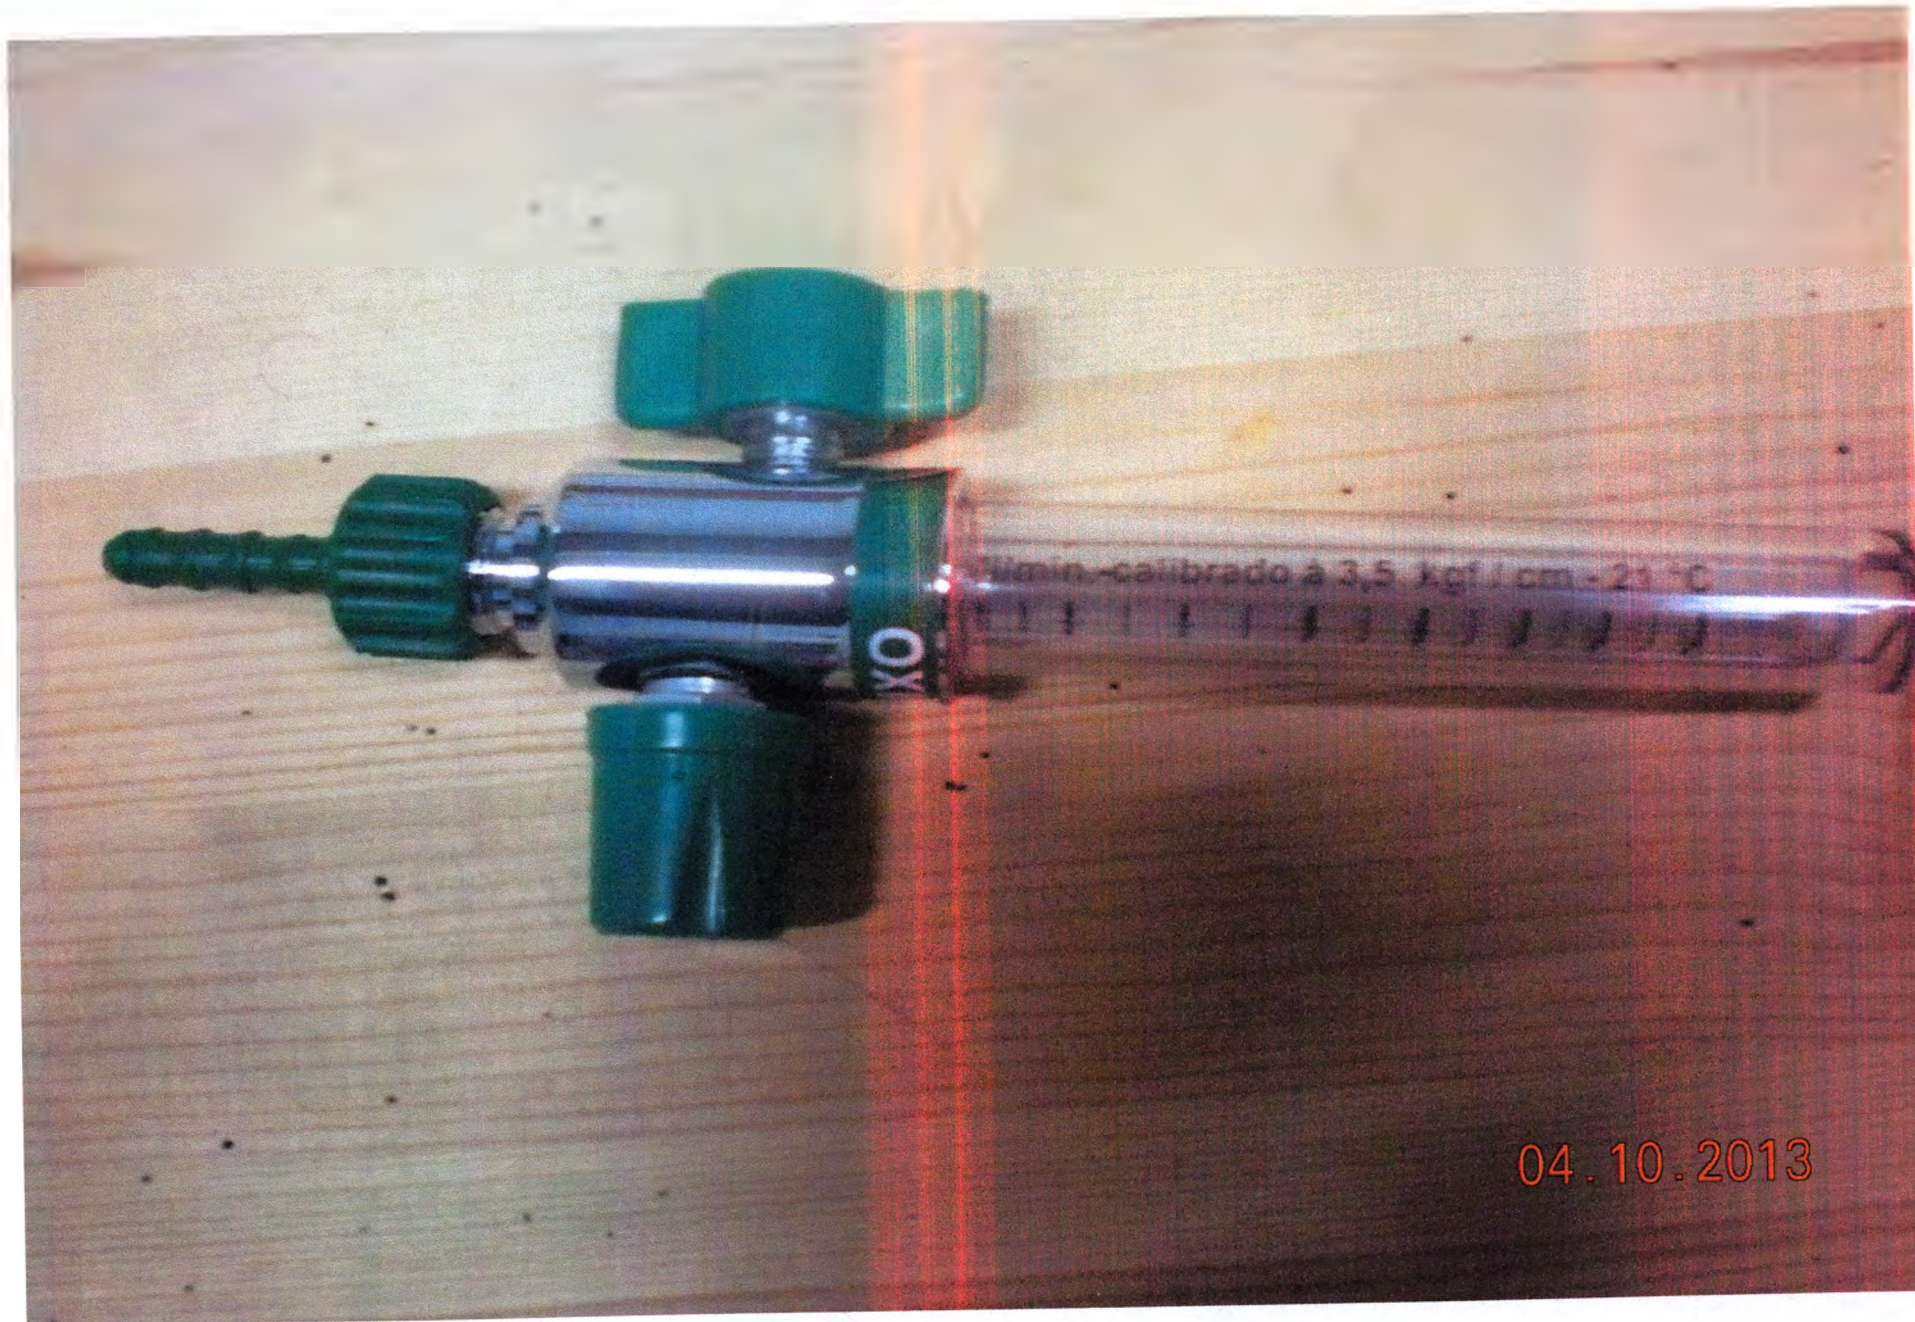


Рис. 31. Флоуметр для кислорода с редуктором.



медицинское оборудование
для профессионалов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов.

должность

подпись

расшифровка

_____ " _____ 20__