

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МКС-Лаборатория»



Г. В. Смирнов

«11» Апреля 2019 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

***Гиалуроновый гель РЕВИ (REVI) стерильный, варианты исполнения:
РЕВИ (REVI) 1,0%, РЕВИ Стайл (REVI Style) 1,0%, РЕВИ Силк (REVI Silk) 1,2%,
РЕВИ Стронг (REVI Strong) 1,5%, в составе:***

- 1. Шприц наполненный 1,0 мл, либо 2,0 мл – 1 шт.;***
- 2. Иглы инъекционные 30G1/2 – 2 шт.;***
- 3. Инструкция по применению – 1 шт.;***
- 4. Стикер-вкладыш с номером партии, датой изготовления и сроком годности
- 2 шт.***

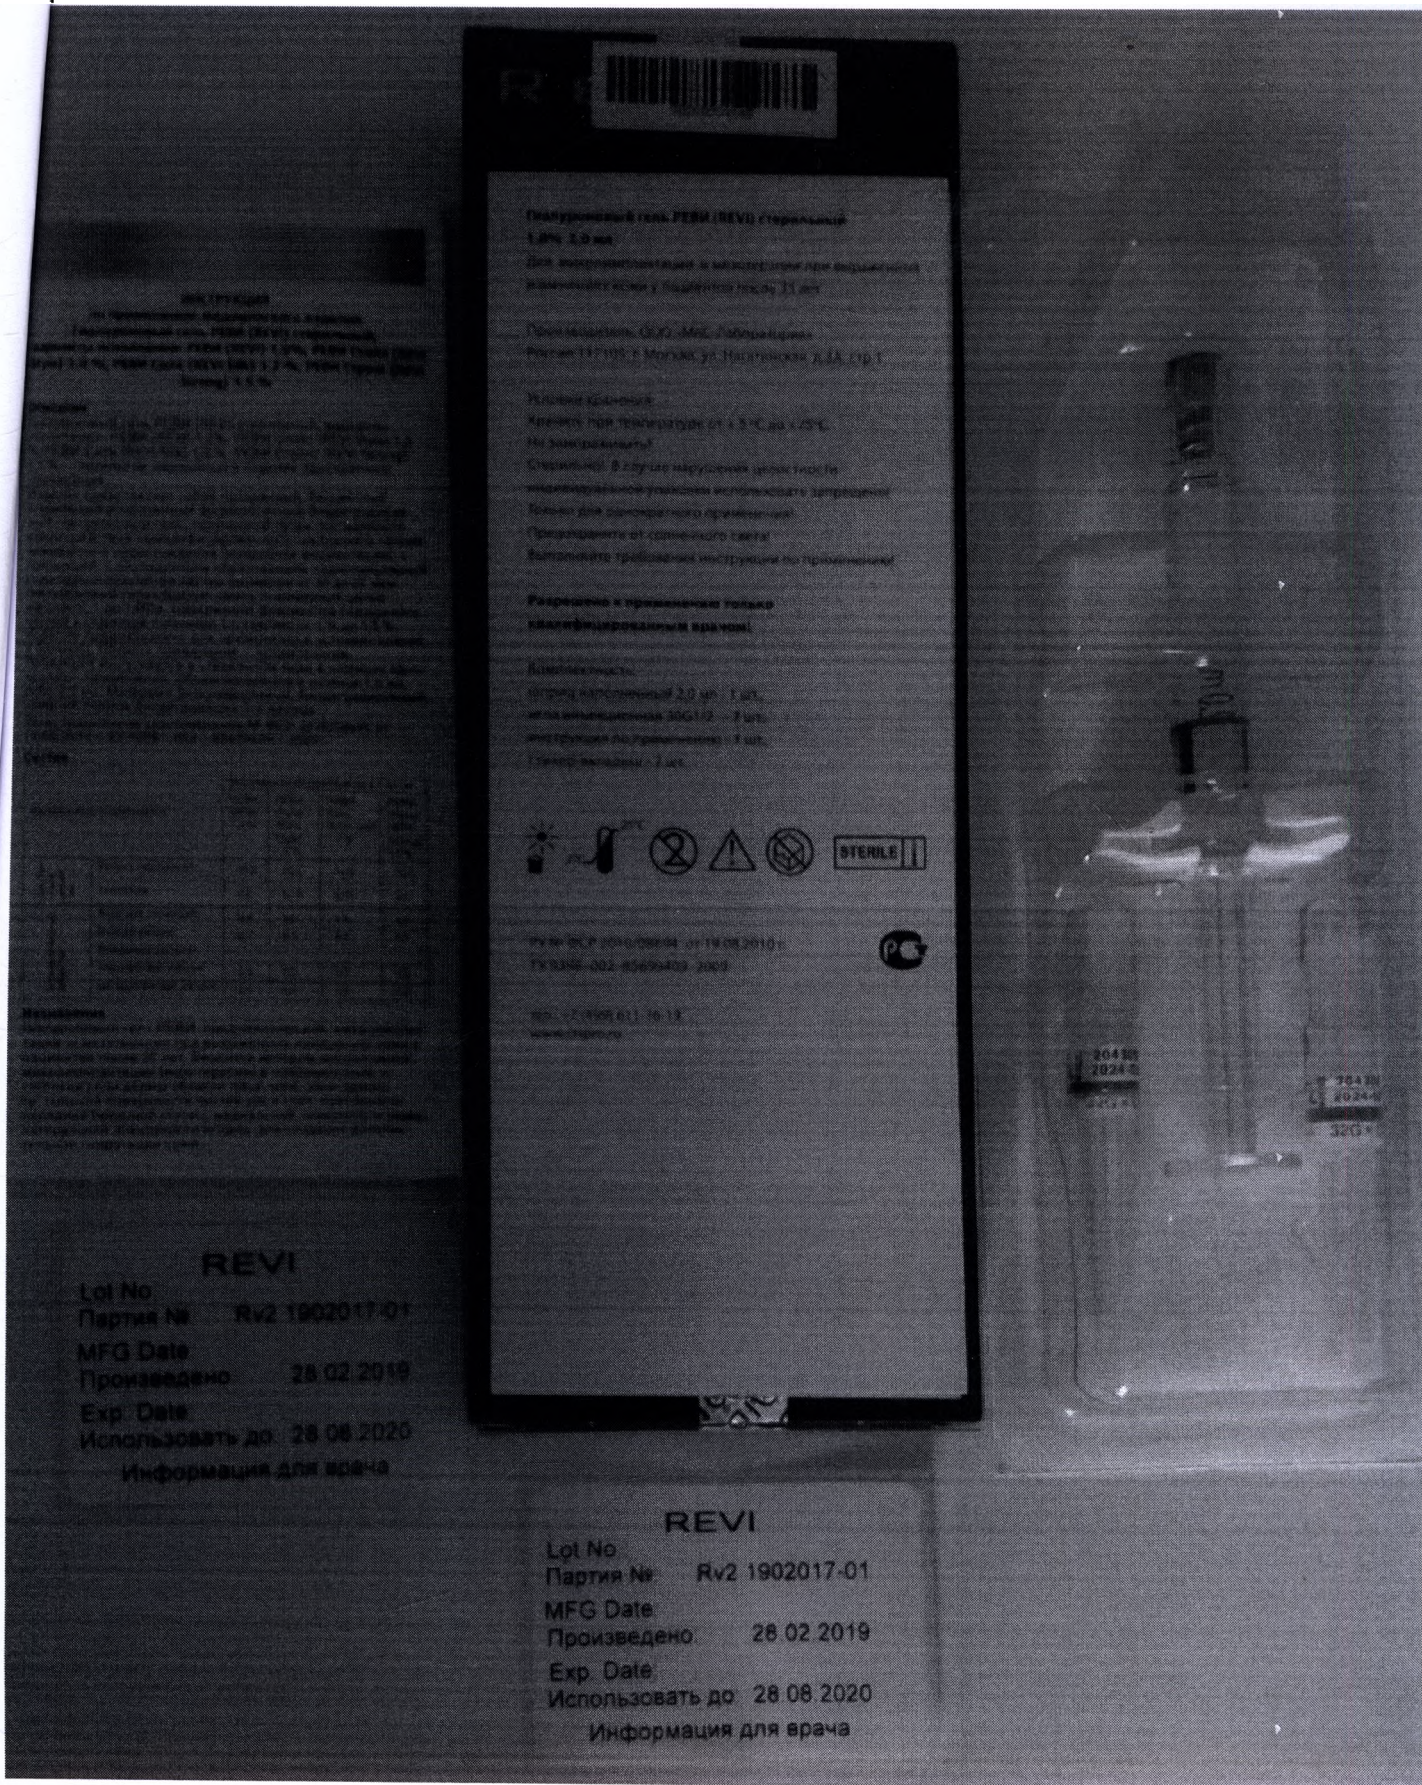


Рис. 1. Гиалуроновый гель РЕВИ (REVI) стерильный 1,0%, номер партии: Rv2 1902017-01

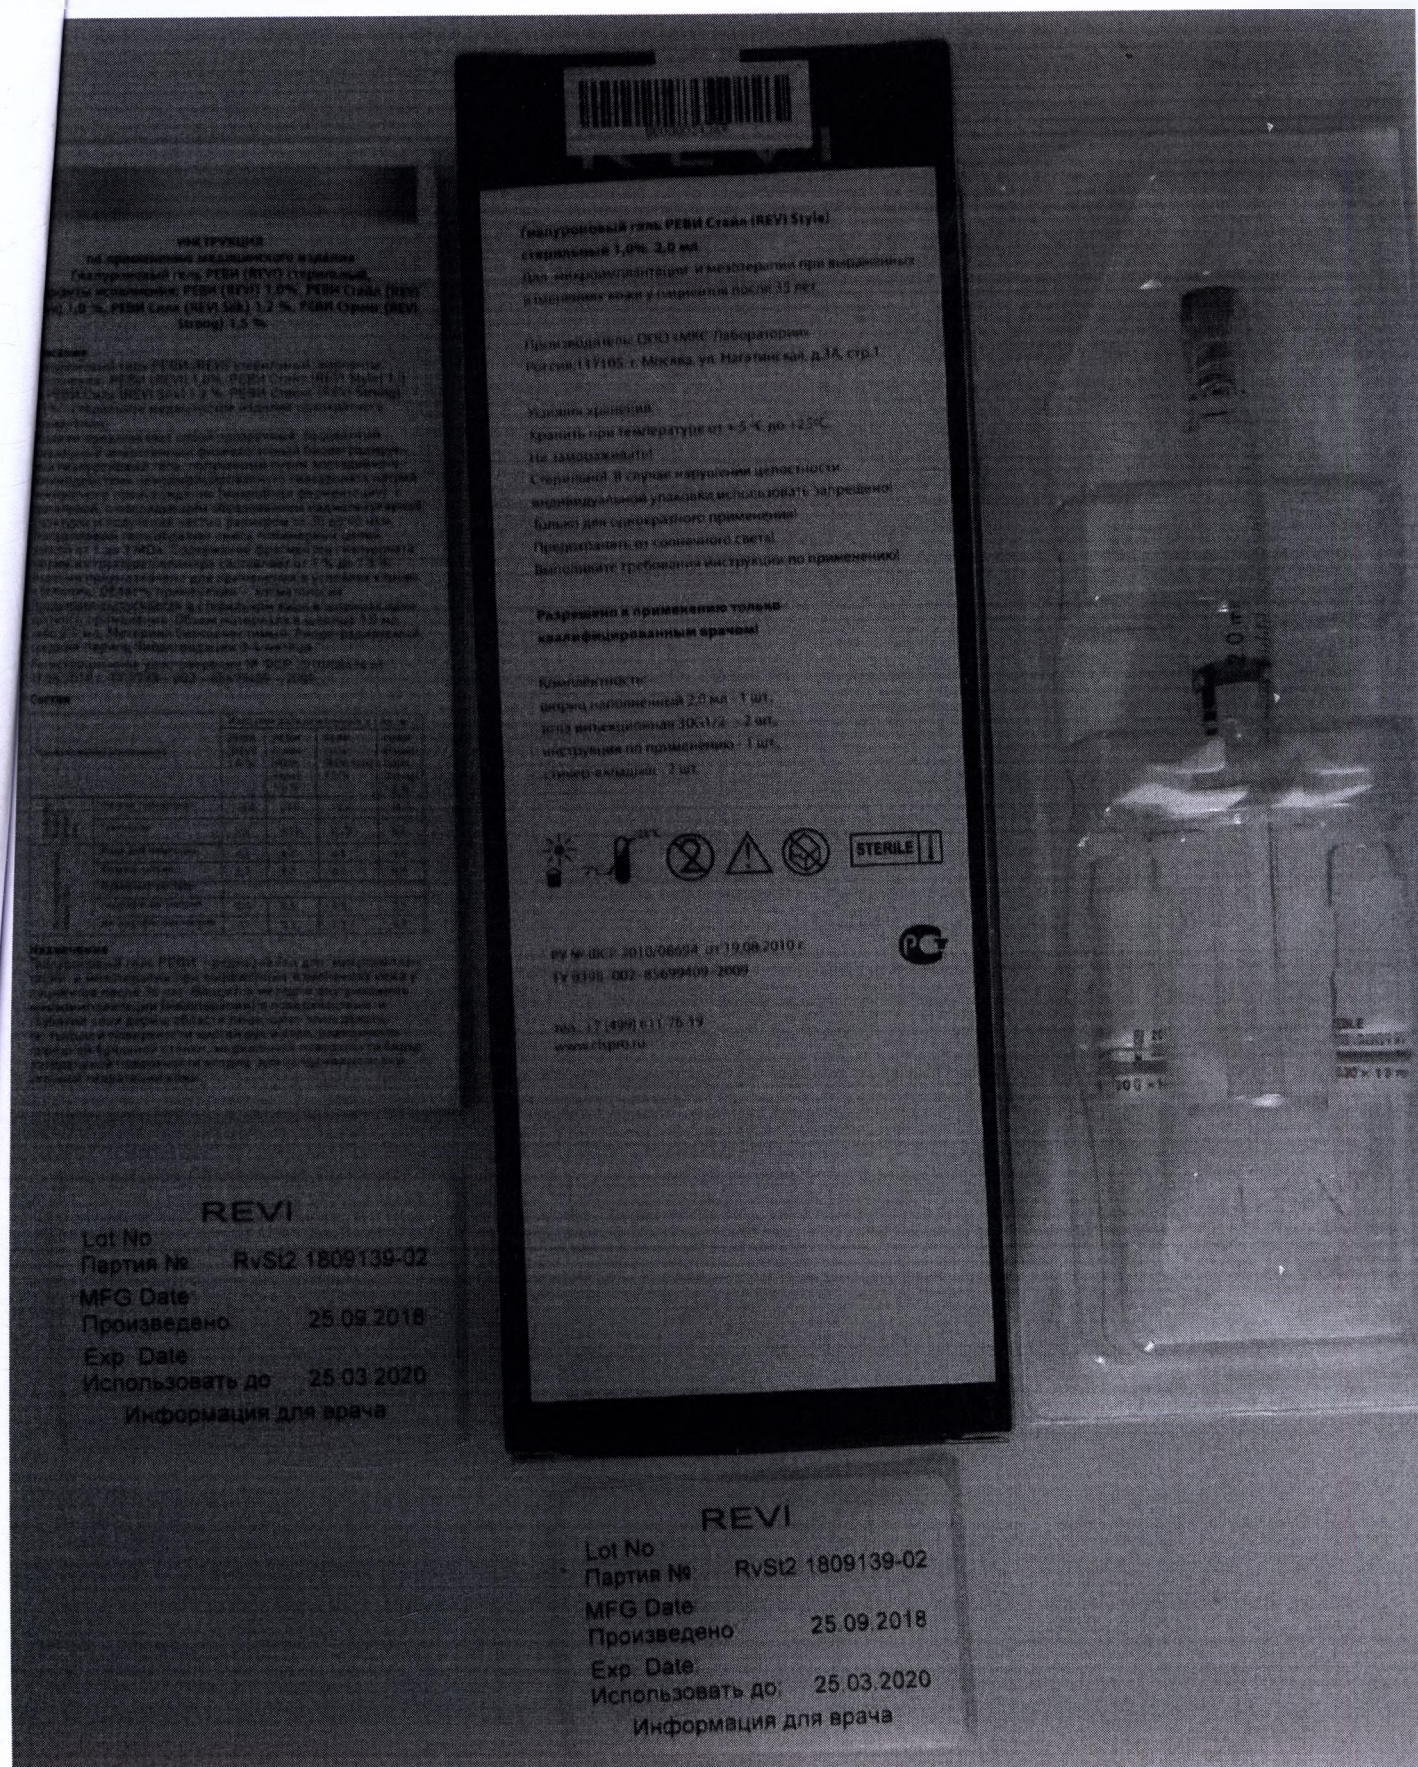


Рис 2. Гиалуроновый гель РЕВИ Стайл (REVI Style) стерильный 1,0%, номер партии: RvSt2 1809139-02

4

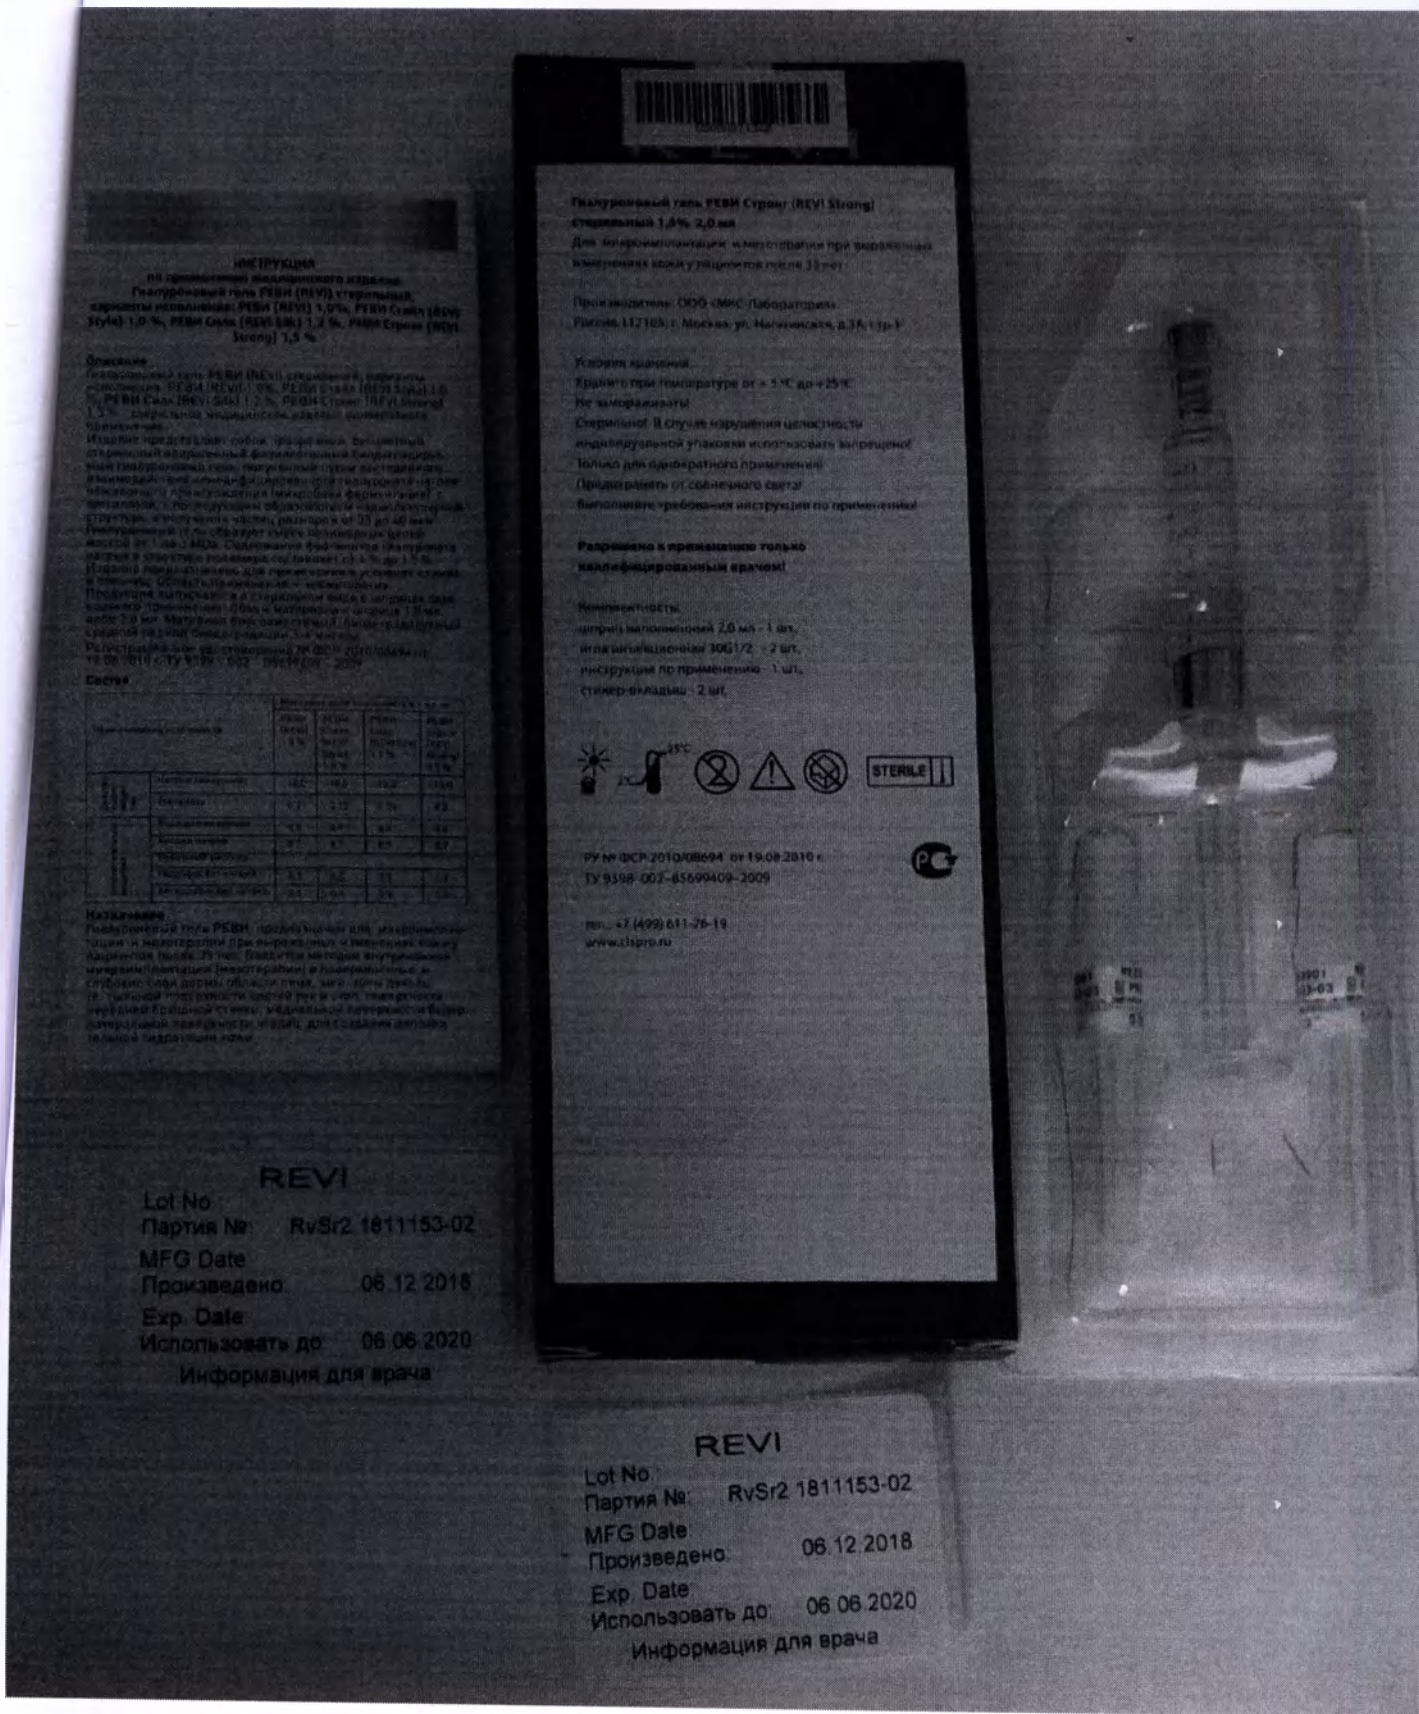


Рис 4. Гиалуроновый гель РЕВИ Стронг (REVI Strong) стерильный 1,5%, номер партии: RvSr2 1811153-02

Пронумеровано и прошито

3 (№96)

листов

Генеральный директор

ООО «МКС-Лаборатория»

Смирнов Г.В.





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МКС-Лаборатория»

Г. В. Смирнов

«Сентябрь» 2018 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

- Гиалуроновый гель РЕВИ (REVI) стерильный, варианты исполнения:***
РЕВИ (REVI) 1,0%, РЕВИ Стайл (REVI Style) 1,0%,
РЕВИ Силк (REVI Silk) 1,2%, РЕВИ Стронг (REVI Strong) 1,5%, в составе:
- 1. Шприц наполненный 1,0 мл, либо 2,0 мл – 1 шт.;***
 - 2. Иглы инъекционные 30G1/2 – 2 шт.;***
 - 3. Инструкция по применению – 1 шт.;***
 - 4. Стикер-вкладыш с номером партии, датой изготовления и сроком годности - 2 шт.***




Рис. 1. Гиалуроновый гель РЕВИ (REVI) стерильный 1,0%, номер партии: Rv1 1806090-01

2. Гиалуроновый гель РЕВИ Стайл (REVI Style) стерильный 1,0%, номер партии: RvSt1 1809139-01

20/А1-08

Внимание!

Шелк. Гиалуроновый гель РЕВИ. Стерильный 1,2%.
 В упаковке 1 шт. 1,0 мл. 1,2%.
 В упаковке 1 шт. 1,0 мл. 1,2%.

ВНИМАНИЕ!

Препарат РЕВИ - это стерильный гиалуроновый гель, который используется для введения в кожу с помощью микроимплантов.

Васильковский уполномоченный представитель имеет право вводить препарат в кожу лица и тела с помощью микроимплантов.

Внимание! Препарат РЕВИ - это стерильный гиалуроновый гель, который используется для введения в кожу с помощью микроимплантов.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат РЕВИ применяется для введения в кожу с помощью микроимплантов. Препарат РЕВИ применяется для введения в кожу с помощью микроимплантов.

УПАКОВКА

Препарат РЕВИ упакован в стерильную упаковку. Препарат РЕВИ упакован в стерильную упаковку.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «МКС-Лаборатория», Россия, 117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 1

ОБЪЕМЫ ПО УПАКОВКАМ

1,0 мл. 1,2%.

REVI

Lot No. RvS11 1809140-01
 Партия № RvS11 1809140-01
 MFG Date 26.09.2018
 Произведено 26.09.2018
 Exp. Date 25.03.2020
 Использовать до 25.03.2020
 Информация для врача

REVI

Lot No. RvS11 1809140-01
 Партия № RvS11 1809140-01
 MFG Date 26.09.2018
 Произведено 26.09.2018
 Exp. Date 25.03.2020
 Использовать до 25.03.2020
 Информация для врача

REVI Silk sterile Hyaluronic Gel 1.0 ml
 For an intradermal microimplants

Produced by MNC-Laboratories Ltd.
 117105, Russia, Moscow, Nagatinskaya str., h.3A, k.1

Storage at temperature from +5°C up to +25°C.
 Do not freeze! Sterile! Do not use in case of damaged package!
 Single use only!
 Protect from sunlight!
 Attention: see instruction for use included.
 The product should be used only by authorized specialist!

Contents: 1 syringe of hyaluronic acid gel, 2 needles, instruction for use, 2 stickers.

Гиалуроновый гель РЕВИ Силк стерильный 1.0 мл
 Для внутрикожной микроимплантации


Произведено: ООО «МКС-Лаборатория»
 117105, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 1

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.
 Не замораживать!
 Стерильно! В случае нарушения целостности индивидуальной упаковки использовать запрещено!
 Только для однократного применения!
 Предохранять от солнечного света!
 Выясните требования инструкции по применению!
 Разрешено к применению только квалифицированным врачом!


Комплектность: шприц наполненный 1,0 мл. 1,2%, игла инъекционная 30G 1/2-2, инструкция по применению 1, стикер вкладыш 2

РУ № ФСР 2010/J00694 от 19.08.2010 г.
 ТУ 9308-002-85690309-2009
 EN ISO 13485:2012

tel: +7 (495) 611-76-19
 www.mncro.ru

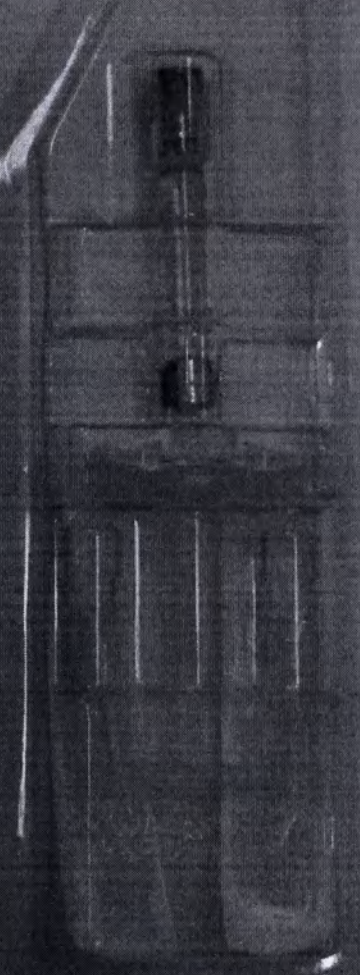

3. Гиалуроновый гель РЕВИ Силк (REVI Silk) стерильный 1,2%, номер партии: RvS11 1809140-01

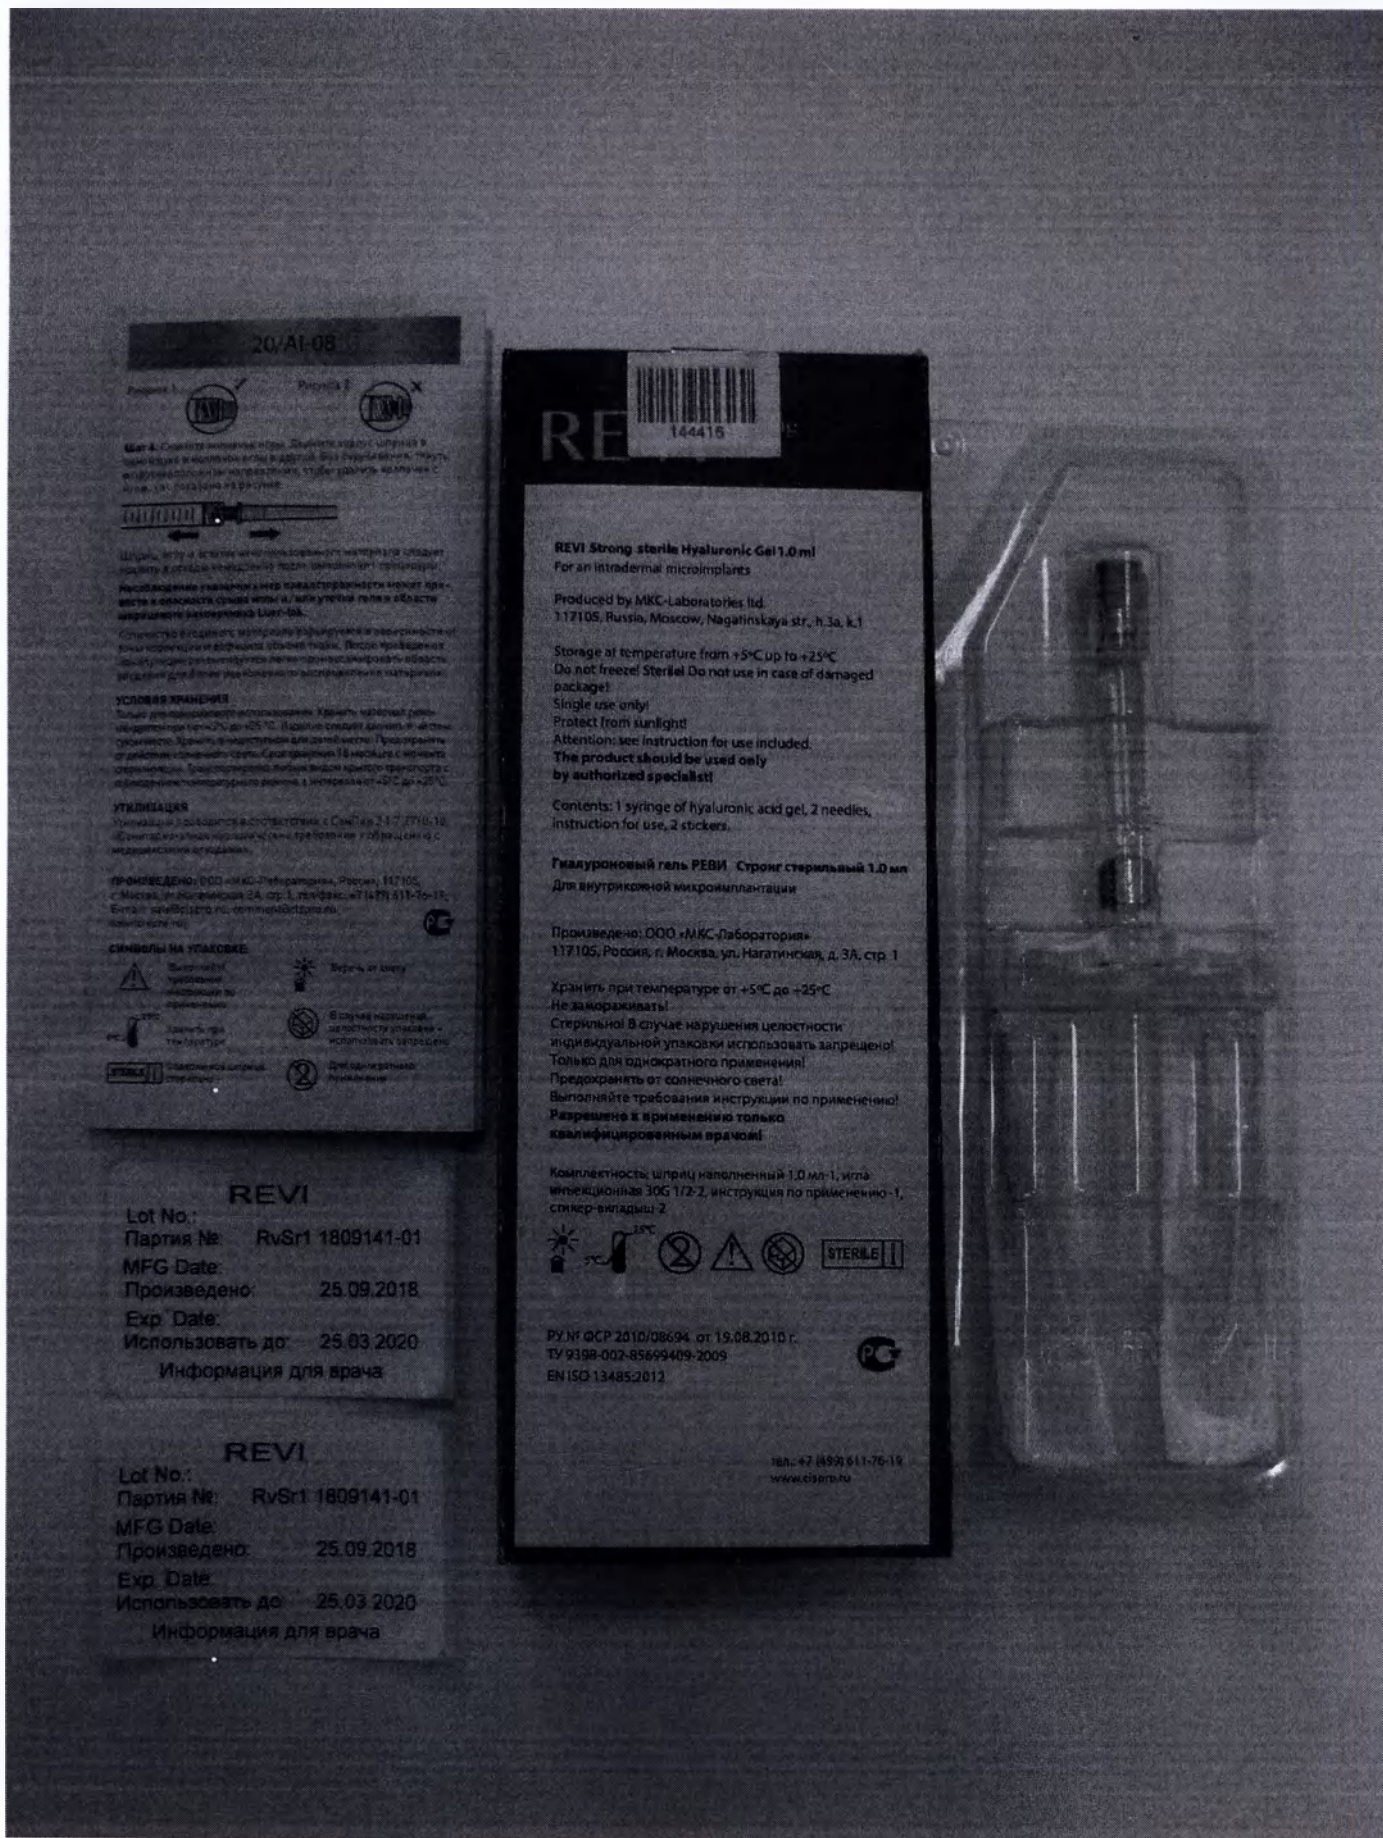

4. Гиалуроновый гель РЕВИ Стронг (REVI Strong) стерильный 1,5%, номер партии: RvSr1 1809141-01

Пронумеровано и прошито

5 (лист)

листов

Генеральный директор

ООО «МКС-Лаборатория»

Смирнов Г.В.

