




Главный научный сотрудник
ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

12 MAR 2018

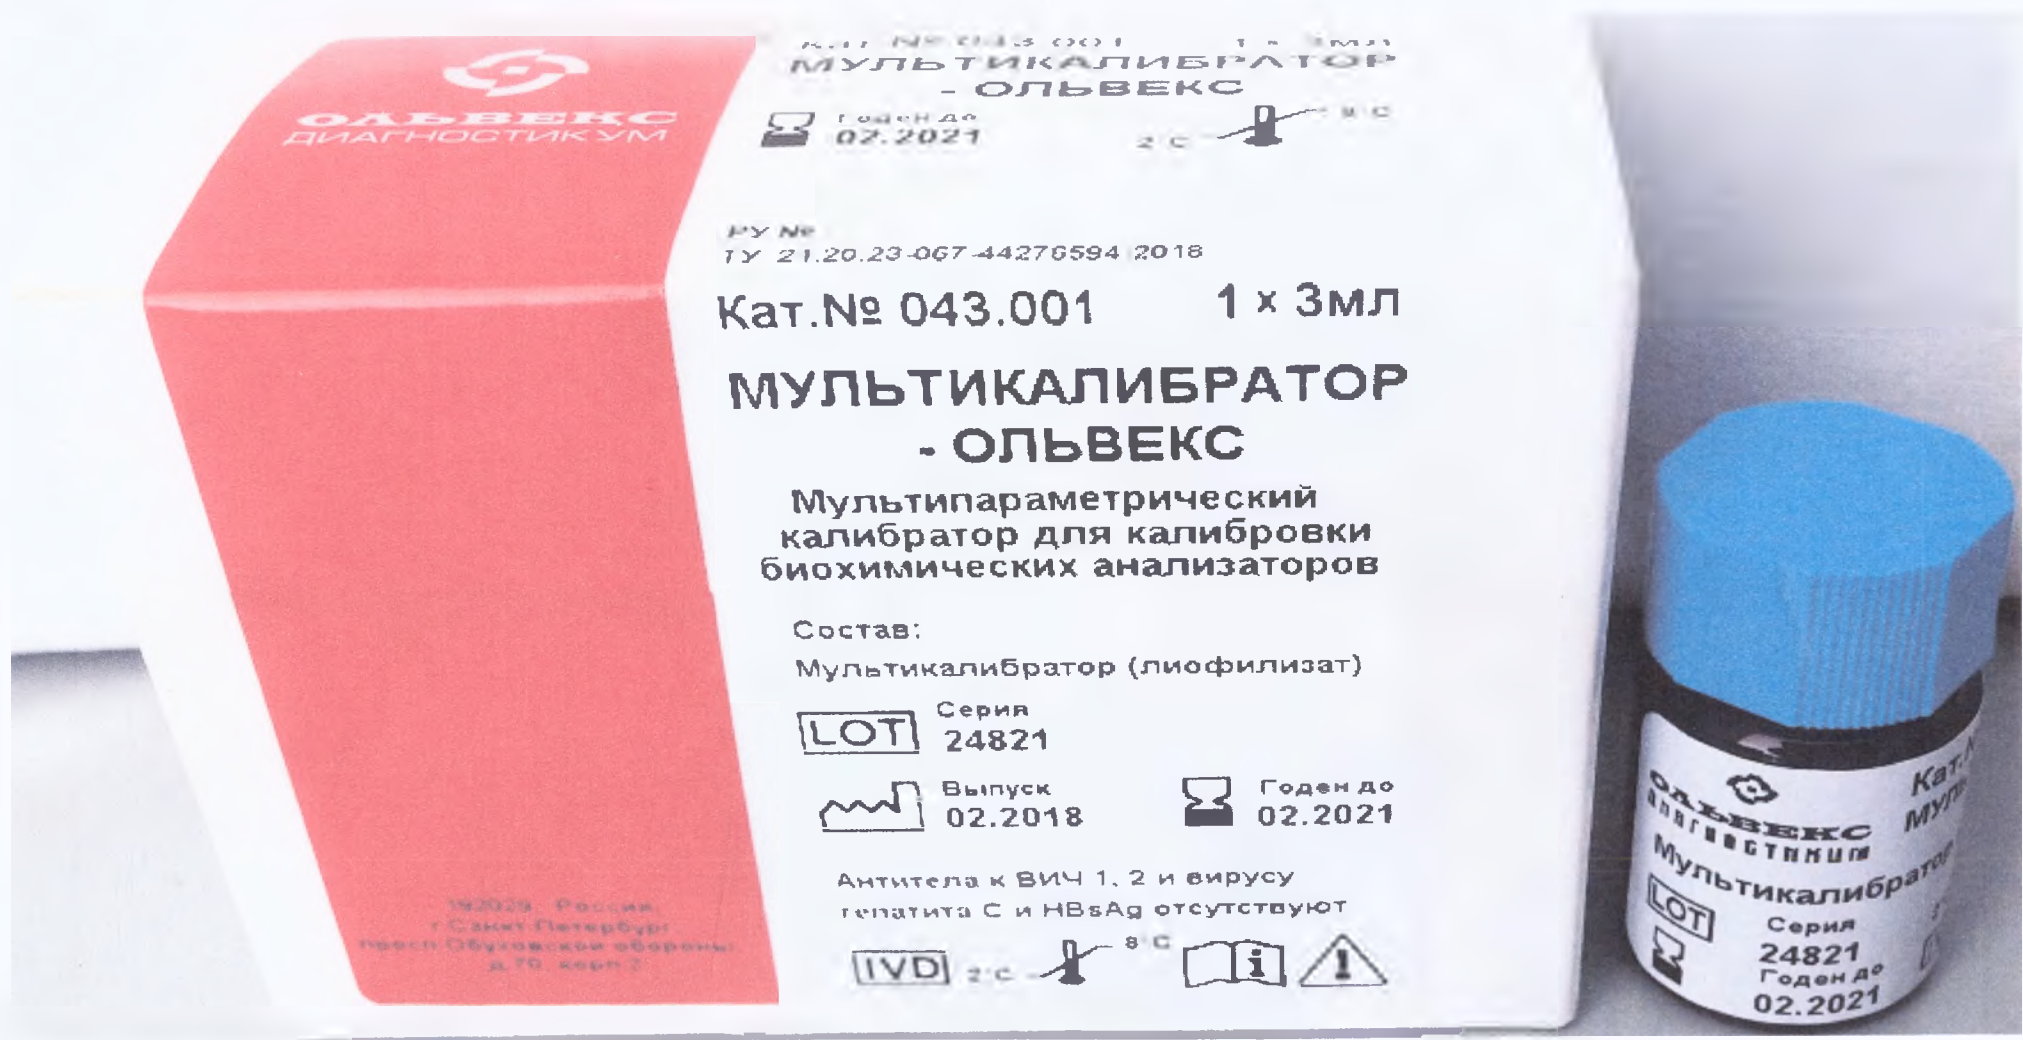

Ющин.К.В.



Главный научный сотрудник
ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

12 MAR 2018



Ющин.К.В.

Образец маркировки групповой упаковки медицинского изделия:

Мультипараметрический калибратор для калибровки биохимических анализаторов
(МУЛЬТИКАЛИБРАТОР-ОЛЬВЕКС) по ТУ 21.20.23-067-44276594-2018

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO:

Мультипараметрический калибратор для калибровки биохимических анализаторов
(МУЛЬТИКАЛИБРАТОР-ОЛЬВЕКС)
по ТУ 21.20.23-067-44276594-2018

кат №:

СРОК ГОДНОСТИ до:

ВЫПУСК:

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: при температуре $+(2-8)^{\circ}\text{C}$

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ: при температуре $+(2-8)^{\circ}\text{C}$

ПАРТИЯ:

СЕРИЯ:

КОЛИЧЕСТВО НАБОРОВ:

МАССА БРУТТО/НЕТТО:

ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

Россия, 192029, г.Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д.70, корп.2, лит.А, пом.1Н



Главный научный сотрудник
ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»

12 MAR 2018



Юцин К.В


Образцы маркировки набора и его компонентов, кат. № 043.001.

Мультипараметрический калибратор для калибровки биохимических анализаторов
(МУЛЬТИКАЛИБРАТОР-ОЛЬВЕКС) по ТУ 21.20.23-067-44276594-2018

Образец маркировки набора реагентов.



Образцы маркировки компонентов набора реагентов.

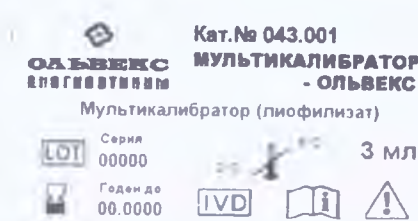

Главный научный сотрудник
ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»
« 12 » марта 2018 г.



К.В. Ющин

Образцы маркировки набора и его компонентов, кат. № 043.011.

Мультипараметрический калибратор для калибровки биохимических анализаторов
(МУЛЬТИКАЛИБРАТОР-ОЛЬВЕКС) по ТУ 21.20.23-067-44276594-2018

Образец маркировки набора реагентов.



Образцы маркировки компонентов набора реагентов.



Главный научный сотрудник
ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»
« 12 » апреля 2018 г.



К.В. Ющин