

117105, ГОРОД МОСКВА,
Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 28А, ЭТАЖ 5 ПОМ. ХIIIA ком.1
Факт. адрес: 117105, ГОРОД МОСКВА,
Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 28А, ЭТАЖ 5 ПОМ. ХIIIA ком.2, 3, 5, 8

+7 (495) 190-00-05
+7 (985) 572-23-30
info@expressm-test.ru
expressm-test.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Мануфактура»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»
Киреев И.В.
« 01 » _____ сентября 2022 г.



ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения
гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной
иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021
Состав 1, Комплект 1 (100 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (15 мл), Реагент 2 – 1 фл. (5 мл), Гемолизующий реагент – 1
фл. (55 мл).

REF 1102H100.1 2021.10
Серия 001 2023.04
8°C
IVD 2°C ру

ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения
гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной
иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021
Состав 2, Комплект 1 (780 определений)
Реагент 1 – 3 фл. (по 39 мл), Реагент 2 – 3 фл. (по 13 мл), Гемолизующий
реагент – 1 фл. (420 мл), Калибратор 1 – 1 фл., Калибратор 2 – 1 фл., Калибратор 3
– 1 фл., Калибратор 4 – 1 фл.
HbA_{1c}, антитела к ВГС и ВИЧ-1,2 отсутствуют

REF 1102H780K.1 2021.10
Серия 017 2023.04
8°C
IVD 2°C ру

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Реагент 1
Состав 1, Комп. 1

LOT 001 2023.04
8°C
15 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Реагент 1
Состав 2, Комп. 1

LOT 017 2023.04
8°C
39 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Реагент 2
Состав 1, Комп. 1

LOT 001 2023.04
8°C
5 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Реагент 2
Состав 2, Комп. 1

LOT 017 2023.04
8°C
13 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Гемолизирующий реагент
Состав 1, Комп. 1

LOT 001 2023.04
8°C
55 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Гемолизирующий реагент
Состав 2, Комп. 1

LOT 017 2023.04
8°C
420 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Калибратор 1
Состав 2, Комп. 1

LOT 017 2023.04
Растворить в 0,5 мл деионизир. Н₂O
Концентрация НbA1c – 4,78%
8°C
2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Калибратор 2
Состав 2, Комп. 1

LOT 017 2023.04
Растворить в 0,5 мл деионизир. Н₂O
Концентрация НbA1c – 8,14%
8°C
2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Калибратор 3
Состав 2, Комп. 1

LOT 017 2023.04
Растворить в 0,5 мл деионизир. Н₂O
Концентрация НbA1c – 11,21%
8°C
2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Калибратор 4
Состав 2, Комп. 1

LOT 017 2023.04
Растворить в 0,5 мл деионизир. Н₂O
Концентрация НbA1c – 13,97%
8°C
2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Калибратор 1
Состав 2, Комп. 6

LOT 022 2023.04
Концентрация НbA1c – 4,78%
8°C
0,5 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Калибратор 2
Состав 2, Комп. 6

LOT 022 2023.04
Концентрация НbA1c – 8,14%
8°C
0,5 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Калибратор 3
Состав 2, Комп. 6

LOT 022 2023.04
Концентрация НbA1c – 11,21%
8°C
0,5 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-НbA1c-Турби»
Калибратор 4
Состав 2, Комп. 6

LOT 022 2023.04
Концентрация НbA1c – 13,97%
8°C
0,5 мл 2°C

Наименование предприятия-изготовителя, контакты, знаки «только для in vitro диагностики» и «обратитесь к инструкции по применению» указаны на этикетке:



ООО «Экспресс Мануфактура»



+7 495-19-0000-5



+7-985-57-2233-0



117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 28А,
этаж 5, пом. XIIIА ком.1.



info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru



Начальник производства

Начальник отдела контроля качества

А.А. Ивчин

М.А. Лесняк



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

2 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»


Киреев И. В.



« 01 » 09 2012 г.



Фотографические изображения общего вида
Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби» по
ТУ 21.20.23-015-40341780-2021

Состав 1 Комплект 1, серия 001 от 2021.10., срок годности до 2023.04.

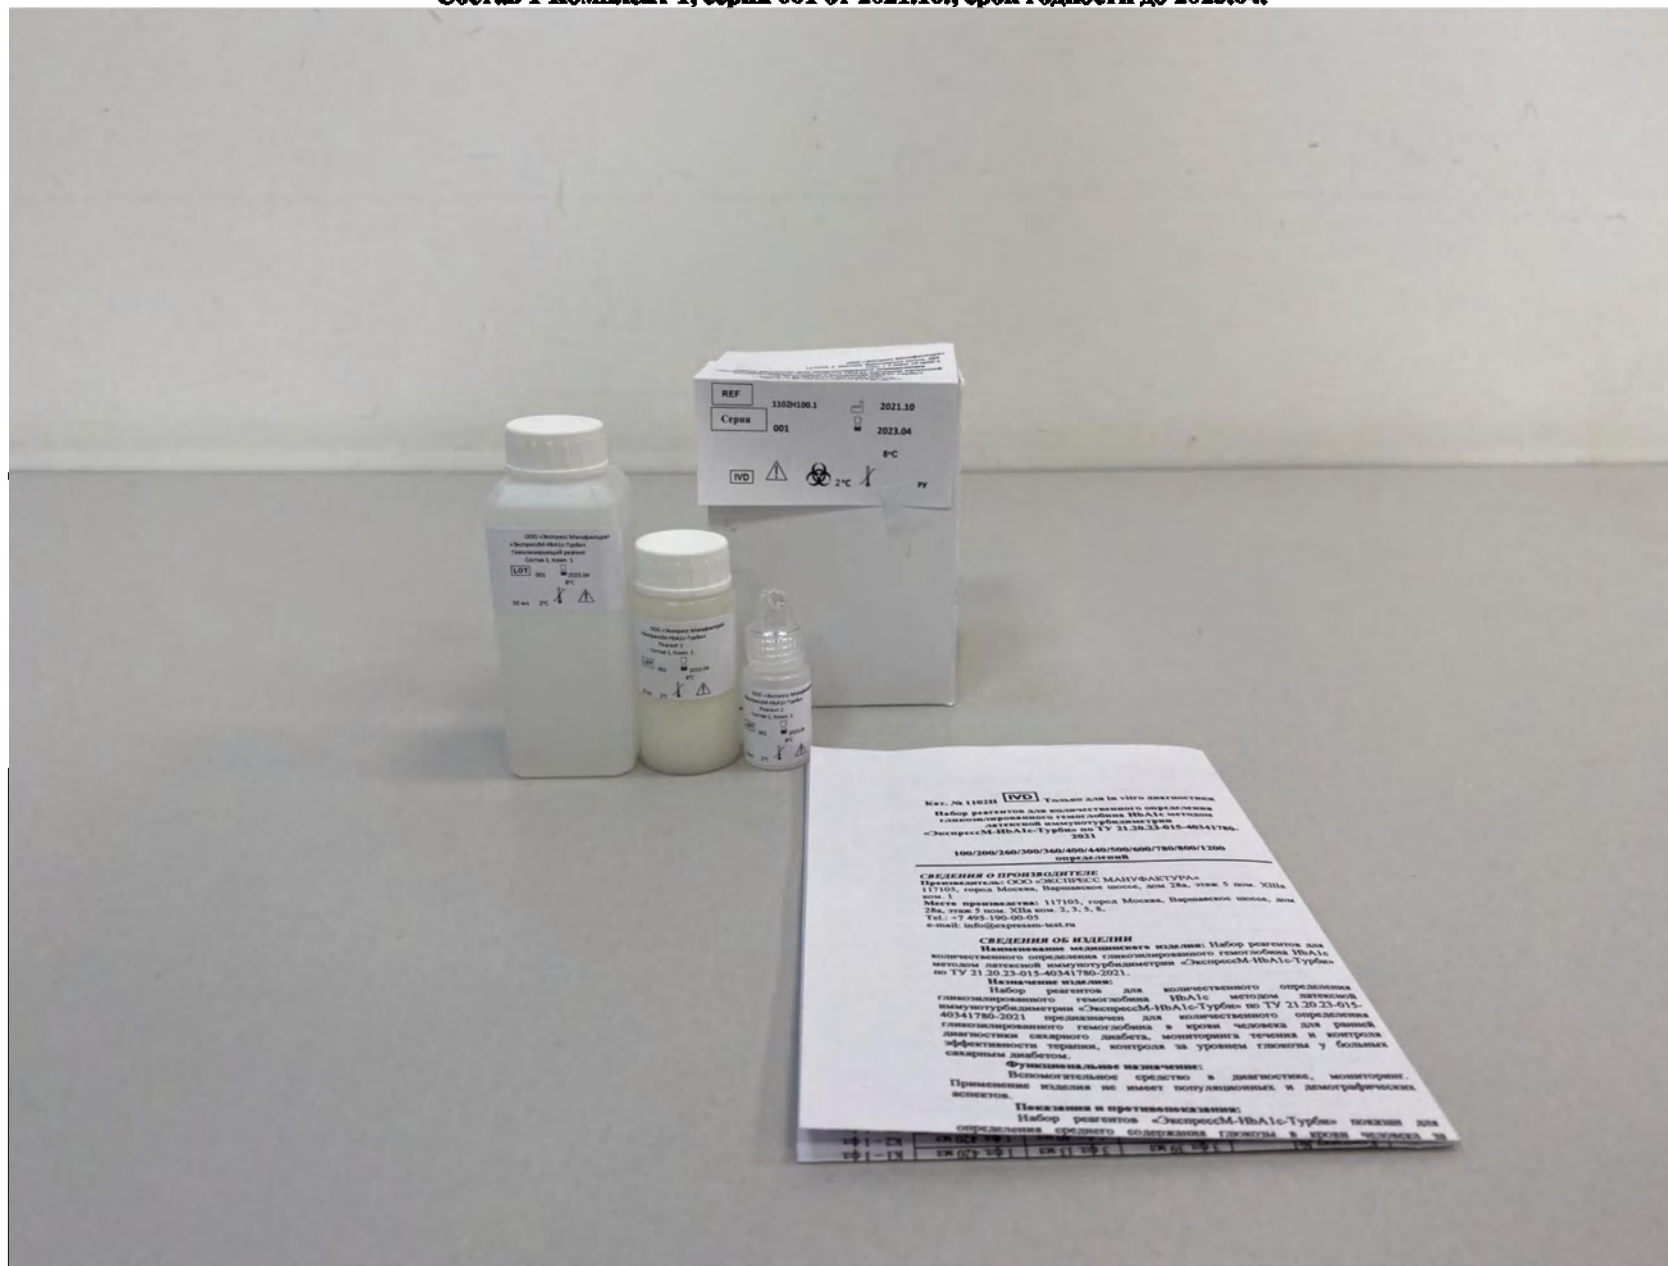

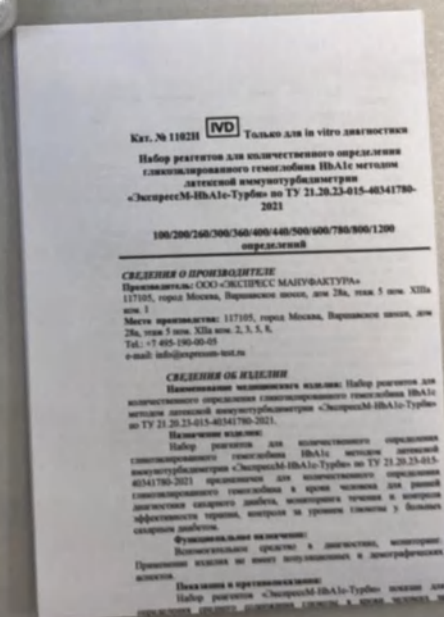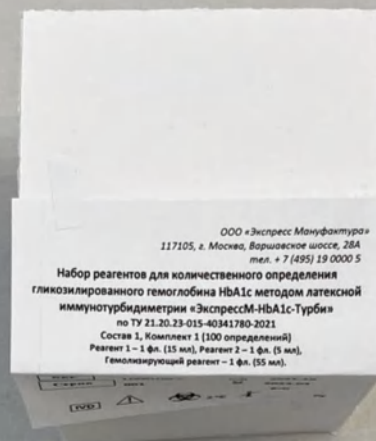



Кат. № 1102H **IVD** Только для in vitro диагностики
 Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина ИbA1c методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ИbA1c-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021
 100/200/260/300/360/400/440/500/600/780/800/1200 определяемых

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»
 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 5 пом. ХIIIIа ком. 1
 Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 5 пом. ХIIIIа ком. 2, 3, 5, 8,
 Tel.: +7 495-190-00-05
 e-mail: info@express-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина ИbA1c методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ИbA1c-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021.
 Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина ИbA1c методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ИbA1c-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021 предназначен для количественного определения гликозилированного гемоглобина в крови человека для оценки эффективности терапии, мониторинга течения и контроля сахарным диабетом.
 Функциональное назначение:
 Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применение изделия не имеет популяционных и демографических аспектов.
 Показания и противопоказания:
 Набор реагентов «Экспресс-ИbA1c-Турби» показан для определения среднего содержания глюкозы в крови человека по



ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения
гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной
иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турбо»
по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021
Состав 1, Комплект 2 (200 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (30 мл), Реагент 2 – 1 фл. (10 мл),
Гемолитизирующий реагент – 1 фл. (110 мл).

Кат. № 110231 **IVD** Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения
гликозилированного гемоглобина HbA1c методом
латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-HbA1c-Турбо» по ТУ 21.20.23-015-40341780-
2021

100/200/300/360/400/440/500/600/780/900/1200
определений


СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 1 пом. ХШБ
ком. 1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом
28А, этаж 1 пом. ХШБ ком. 2, 3, 5, 6.
Тел.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@express-man.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для
количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA1c
методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турбо»
по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021.

Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения
гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной
иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турбо» по ТУ 21.20.23-015-
40341780-2021 предназначен для количественного определения
гликозилированного гемоглобина в крови человека для рутинной
диагностики сахарного диабета, мониторинга течения и контроля
эффективности терапии, контроля за уровнем гликемии у больных
сахарным диабетом.

Функциональные назначения:
Высокоэффективное средство в диагностике, мониторинге
Применение изделия не имеет противопоказаний и ограничений
по возрасту.

Показания и противопоказания:
Набор реагентов «ЭкспрессМ-HbA1c-Турбо» предназначен для
определения уровня гликозилированного гемоглобина в крови человека по

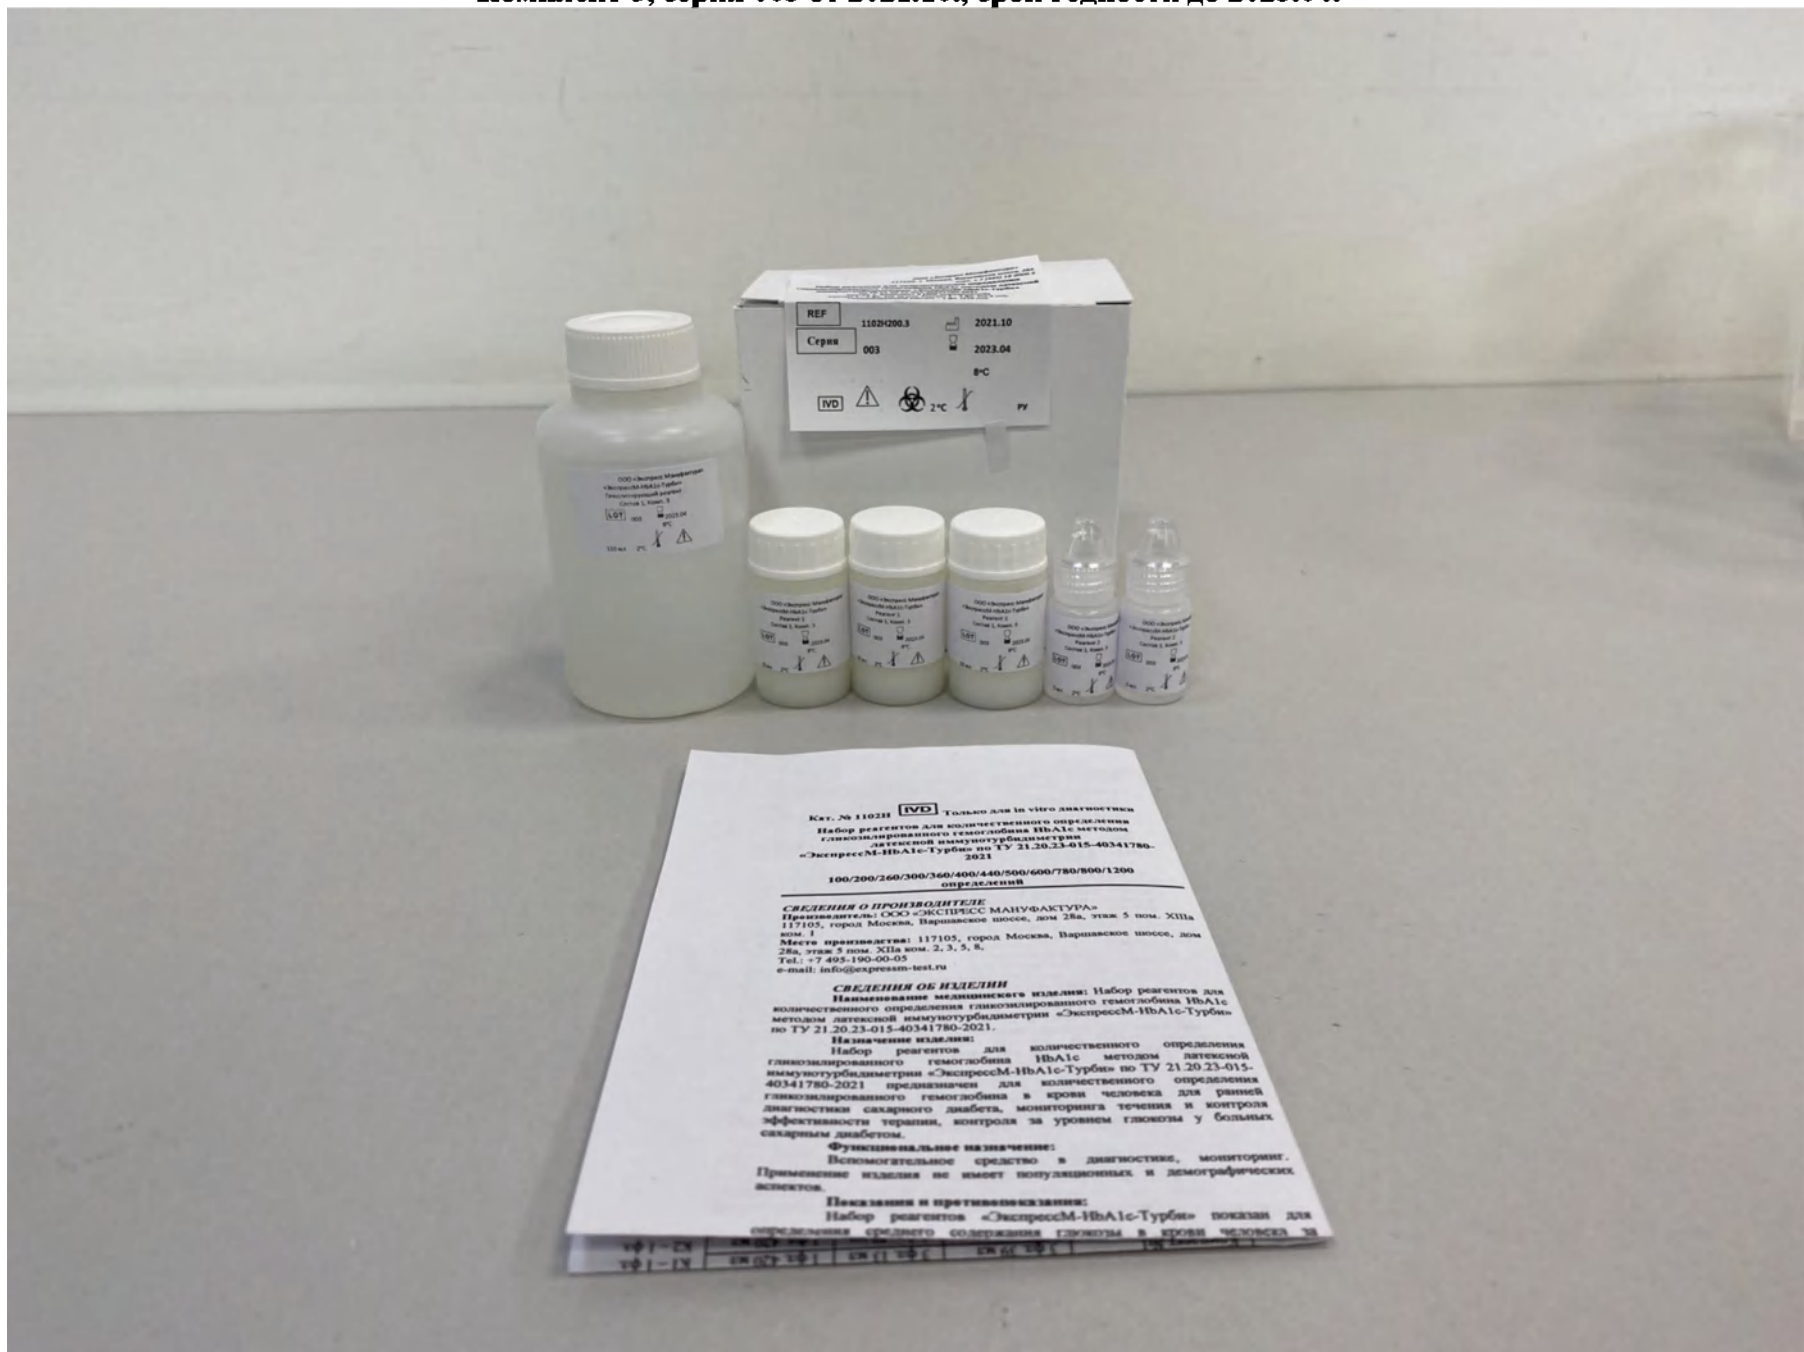

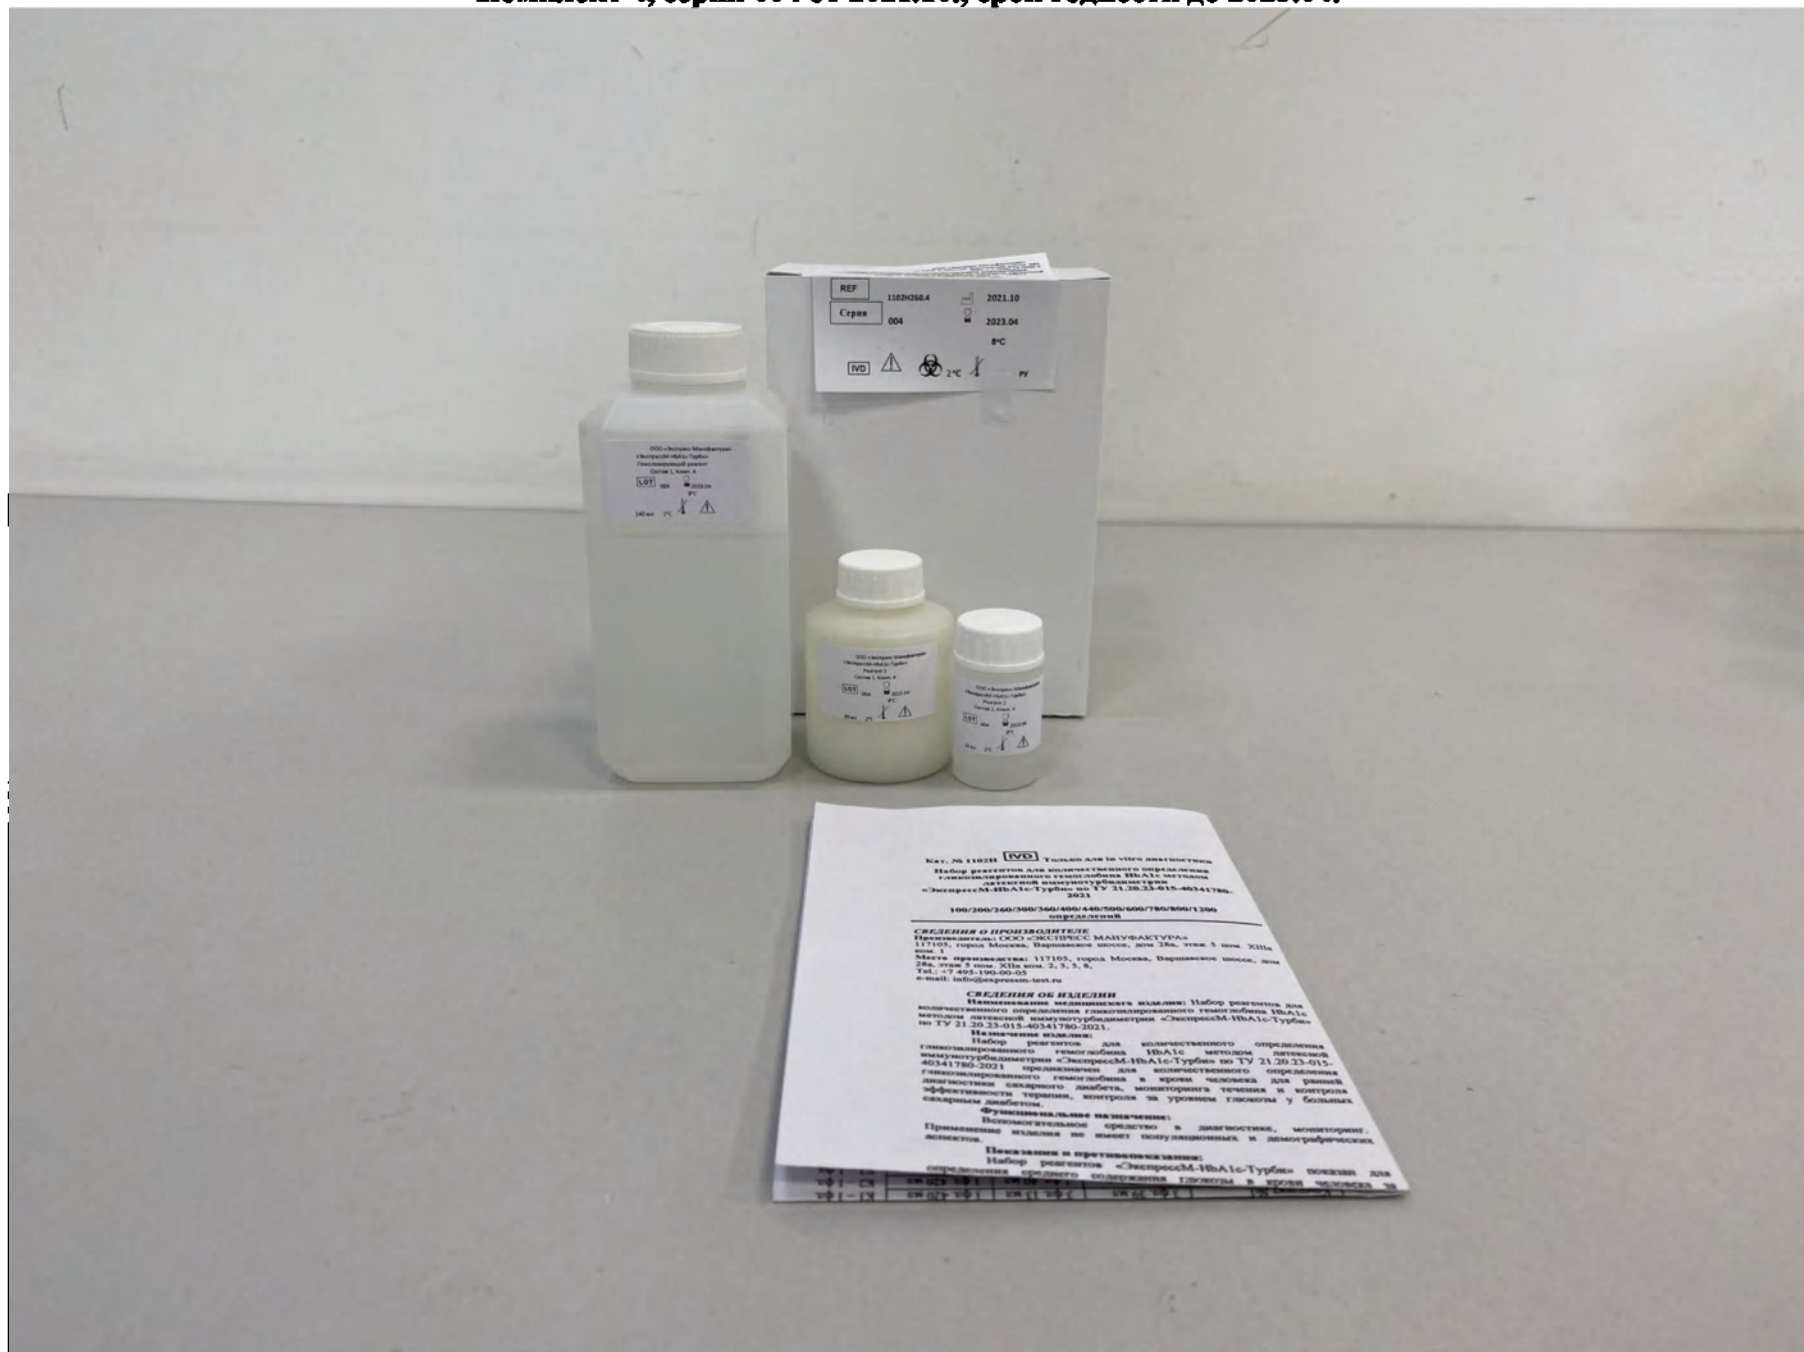




Кат. № 1182H **IVD** Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA_{1c} методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA_{1c}-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021

180/200/240/300/340/400/440/500/600/700/800/1200
экспресс.гем.гб

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производители: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»
 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3 пом. X/3а
 этаж 3
 Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3 пом. X/3а этаж 3, 3, 3, 3, 3
 Тел.: +7 495 190-00-02
 e-mail: info@express-man.ru

СВЕДЕНИЯ О ВРЕЗНИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA_{1c} методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA_{1c}-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021.
 Наименование изделия: Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA_{1c} методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA_{1c}-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021 предназначен для количественного определения гликозилированного гемоглобина в крови человека для ранней диагностики сахарного диабета, мониторинга течения и контроля эффективности терапии, контроля и оценки состояния у больных сахарным диабетом.
 Функциональные назначения: Высокочувствительные препараты в диагностике, мониторинге. Применяются изделия не имеют противопоказаний к диагностическим аспектам.
 Показания к применению: Набор реагентов «ЭкспрессМ-HbA_{1c}-Турби» применим для определения содержания гликозилированного гемоглобина в крови человека и

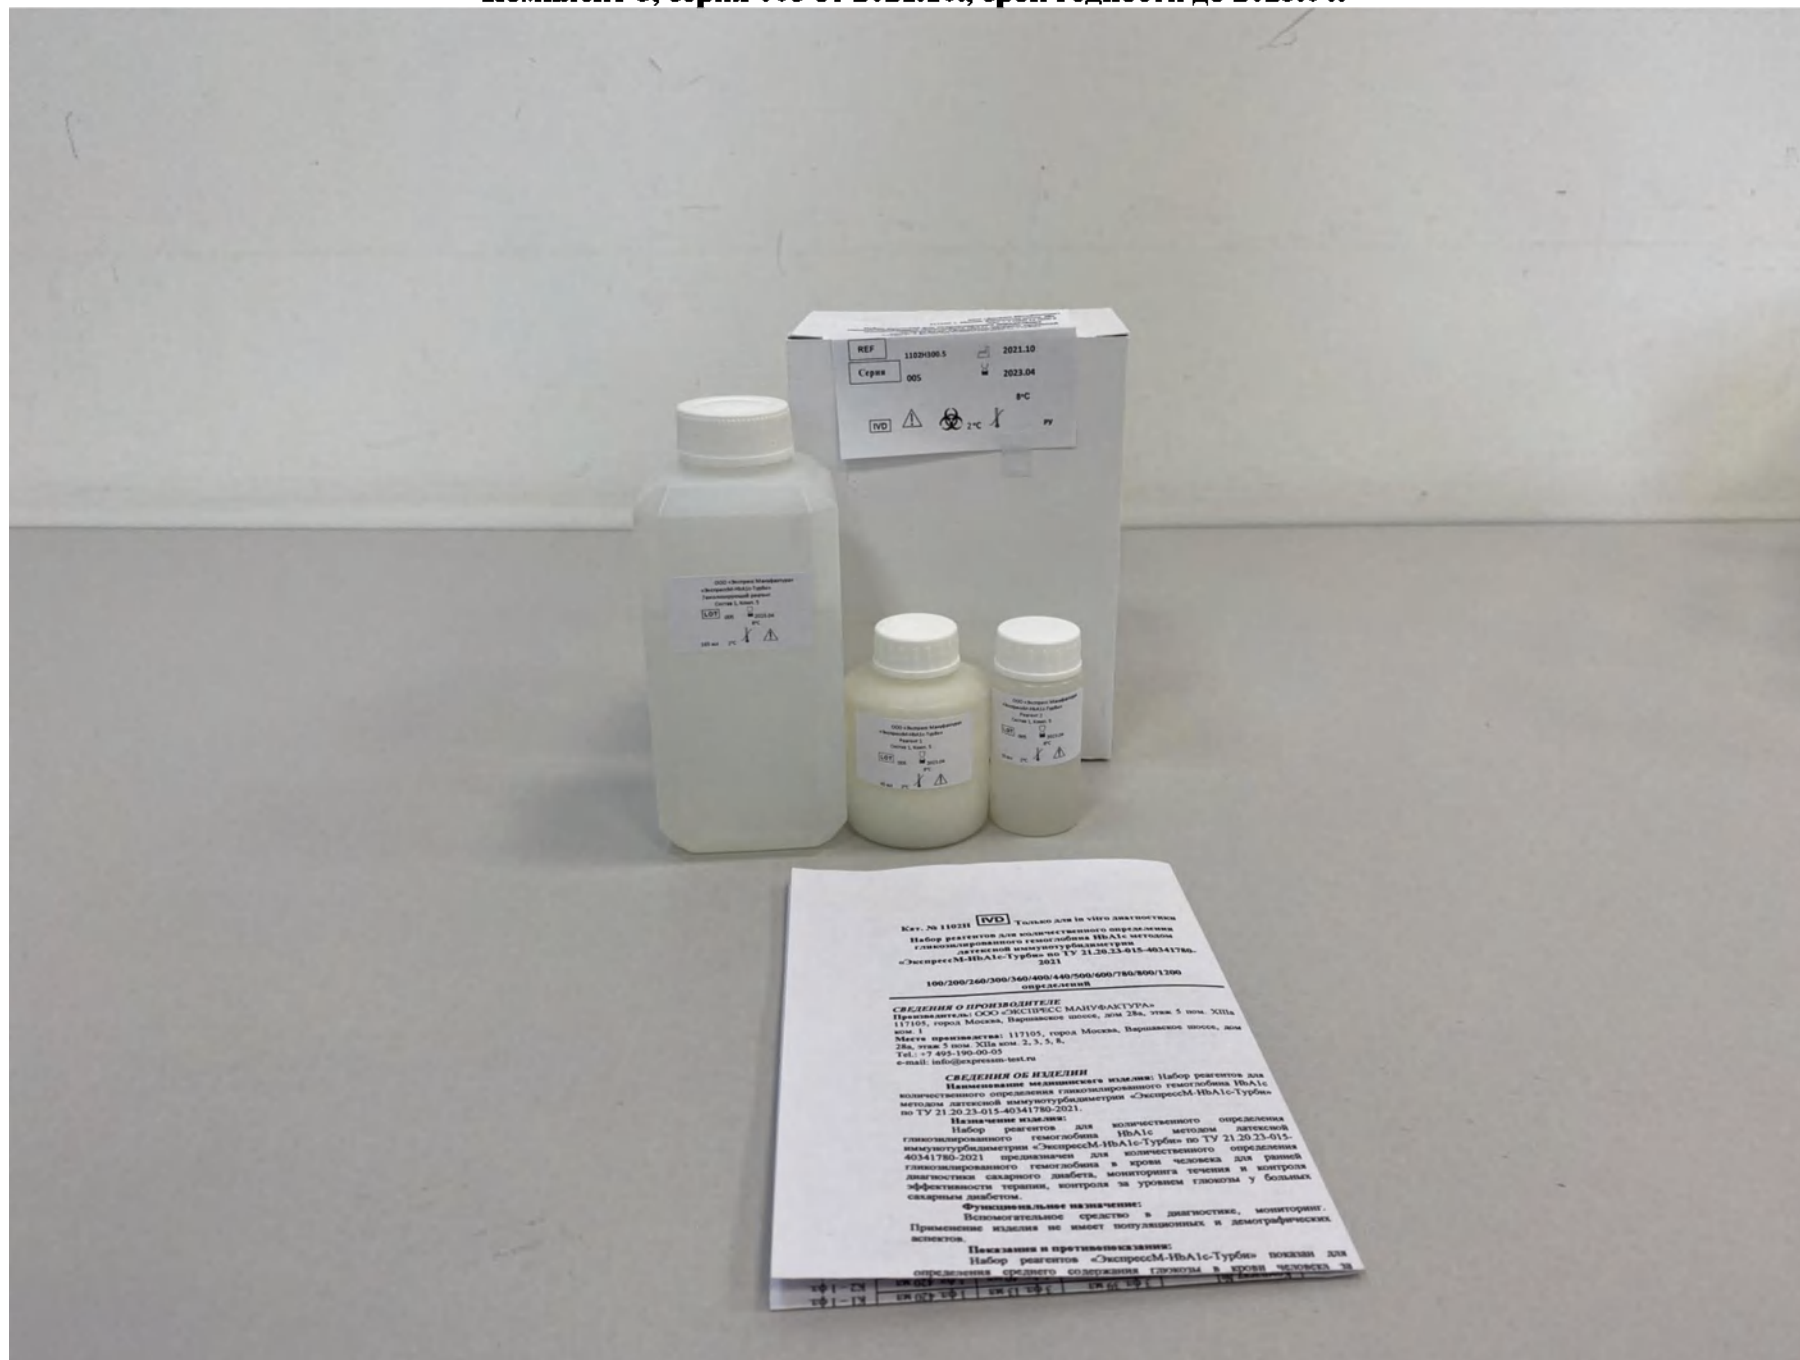




Кат. № 11828 **IVD** Только для **in vitro** диагностики


Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA_{1c} методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA_{1c}-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021


100/200/250/300/500/600/800/900/1000/1200 мкг/мл/мкл

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «Экспресс Мануфактура»
 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, этаж 3, пом. 3
 Место производства: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, этаж 3, пом. 3, 3.3, 3.4
 Тел.: +7 495 190-09-03
 e-mail: info@expres-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA_{1c} методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA_{1c}-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021.
 Наименование изделия: Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA_{1c} методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA_{1c}-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021, предназначен для количественного определения гликозилированного гемоглобина в крови человека для ранней диагностики сахарного диабета, мониторинга течения и контроля эффективности терапии, контроля за уровнем гликемии у больных сахарным диабетом.
 Функциональные назначения: Высокочувствительные средства в диагностике, мониторинге. Приспособлены к использованию в диагностических системах.
 Назначения и противопоказания: Набор реагентов «ЭкспрессМ-HbA_{1c}-Турби» можно для определения уровня гликемии, гликемии, г. гликемии, г.

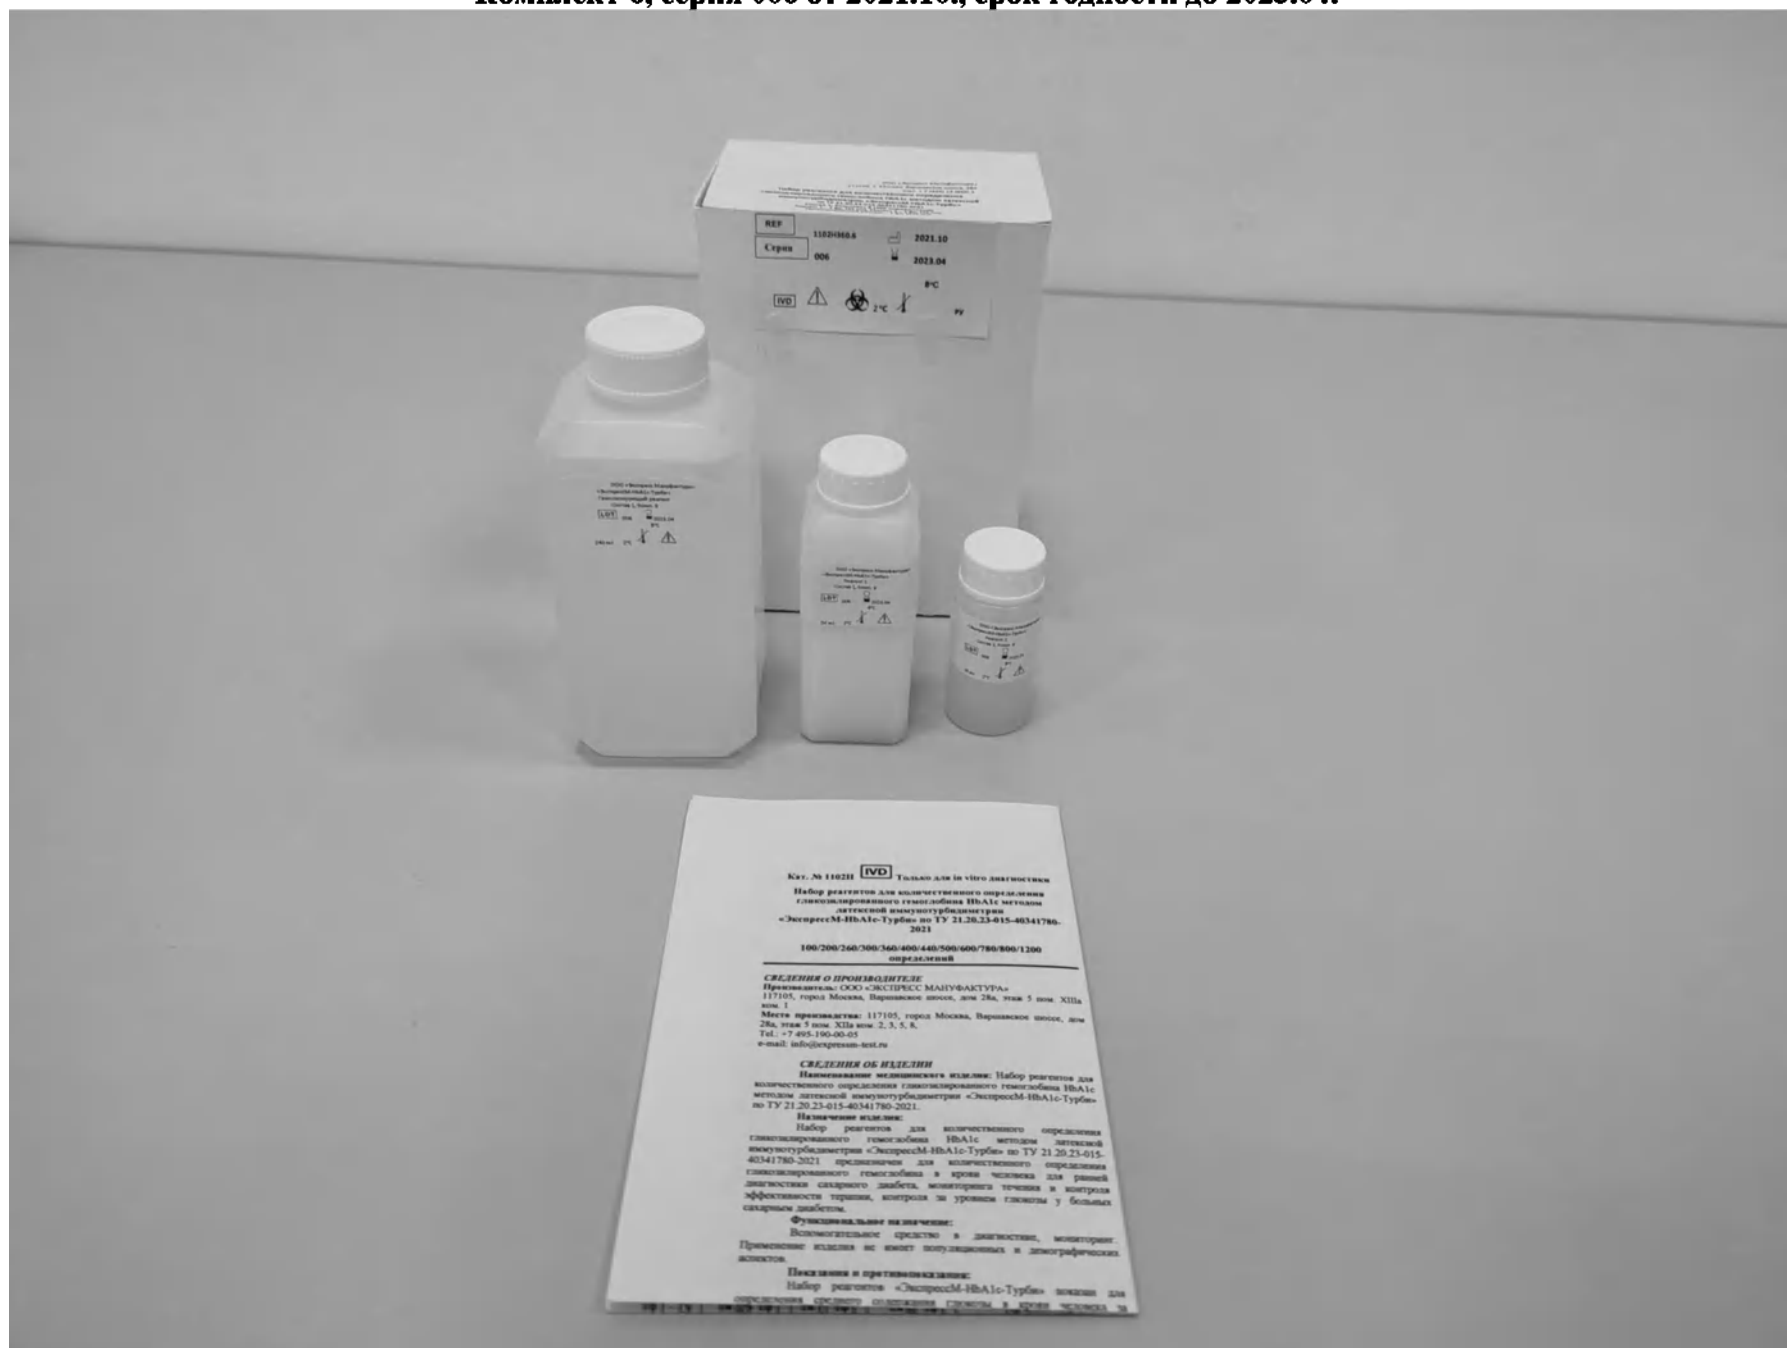

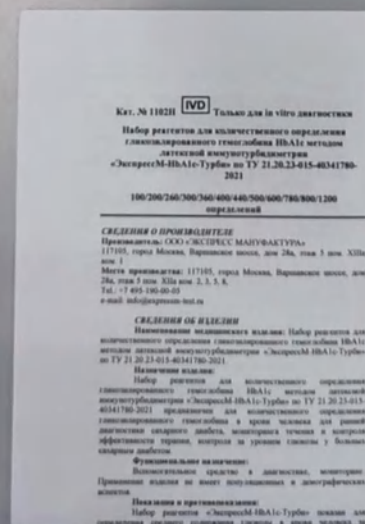

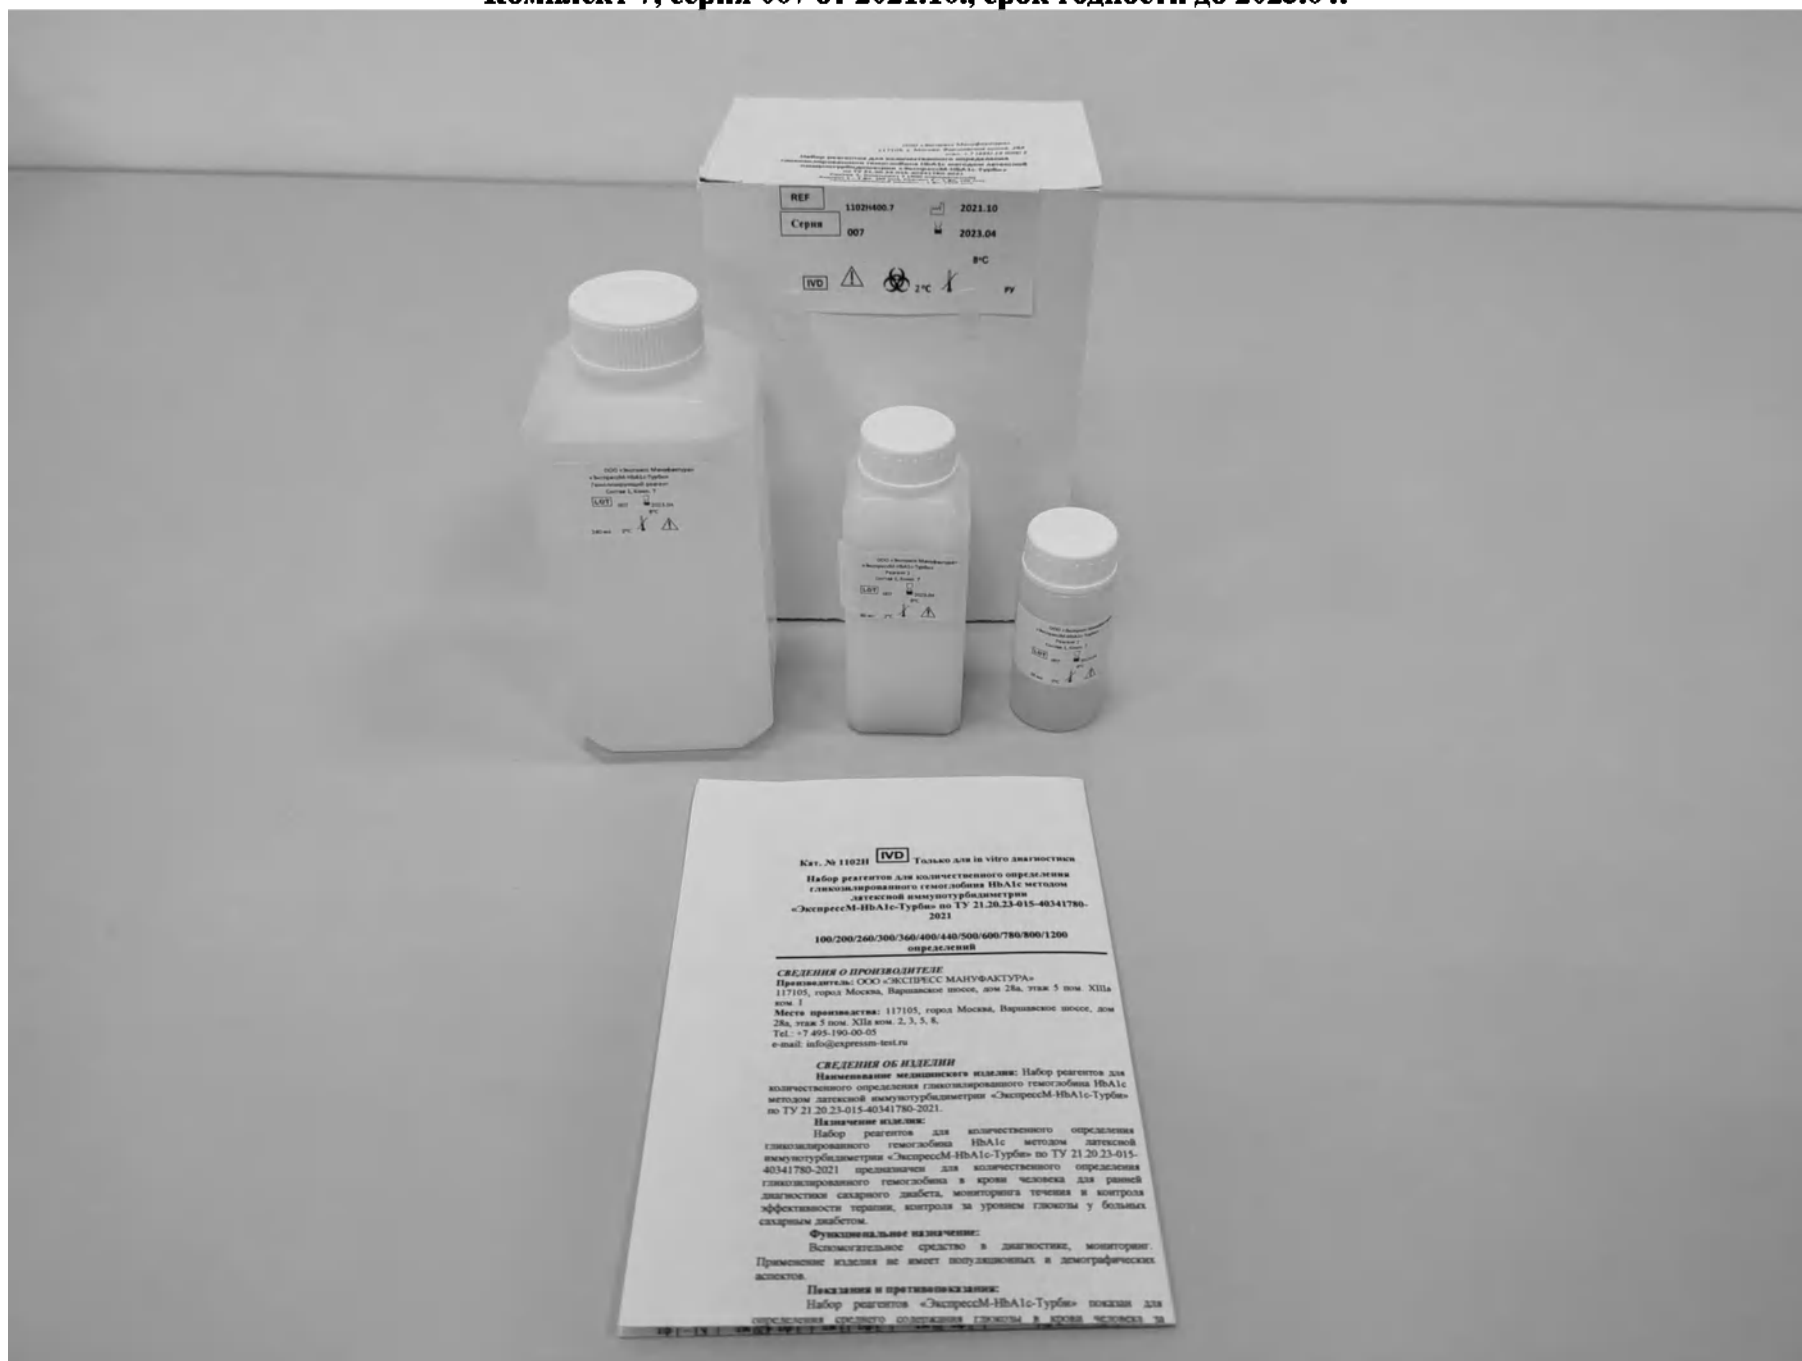




Кат. № 110211 **IVD** Только для in vitro диагностики


Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021


100/200/260/300/360/400/440/500/600/780/900/1200 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»
 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 5 пом. XIII
 пом. 1
 Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 5 пом. XIII пом. 2, 3, 4, 6
 Тел.: +7 495 190-00-03
 e-mail: info@express-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021.
 Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021 применяется для количественного определения гликозилированного гемоглобина в крови человека для целей диагностики сахарного диабета, мониторинга течения и контроля эффективности терапии, контроля за уровнем гликемии у больных сахарным диабетом.
 Функциональное назначение:
 Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применение изделия не имеет противопоказаний и ограничений по возрасту.
 Назначение и применение изделия:
 Набор реагентов «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби» применяют для определения содержания гликозилированного гемоглобина в крови человека, при

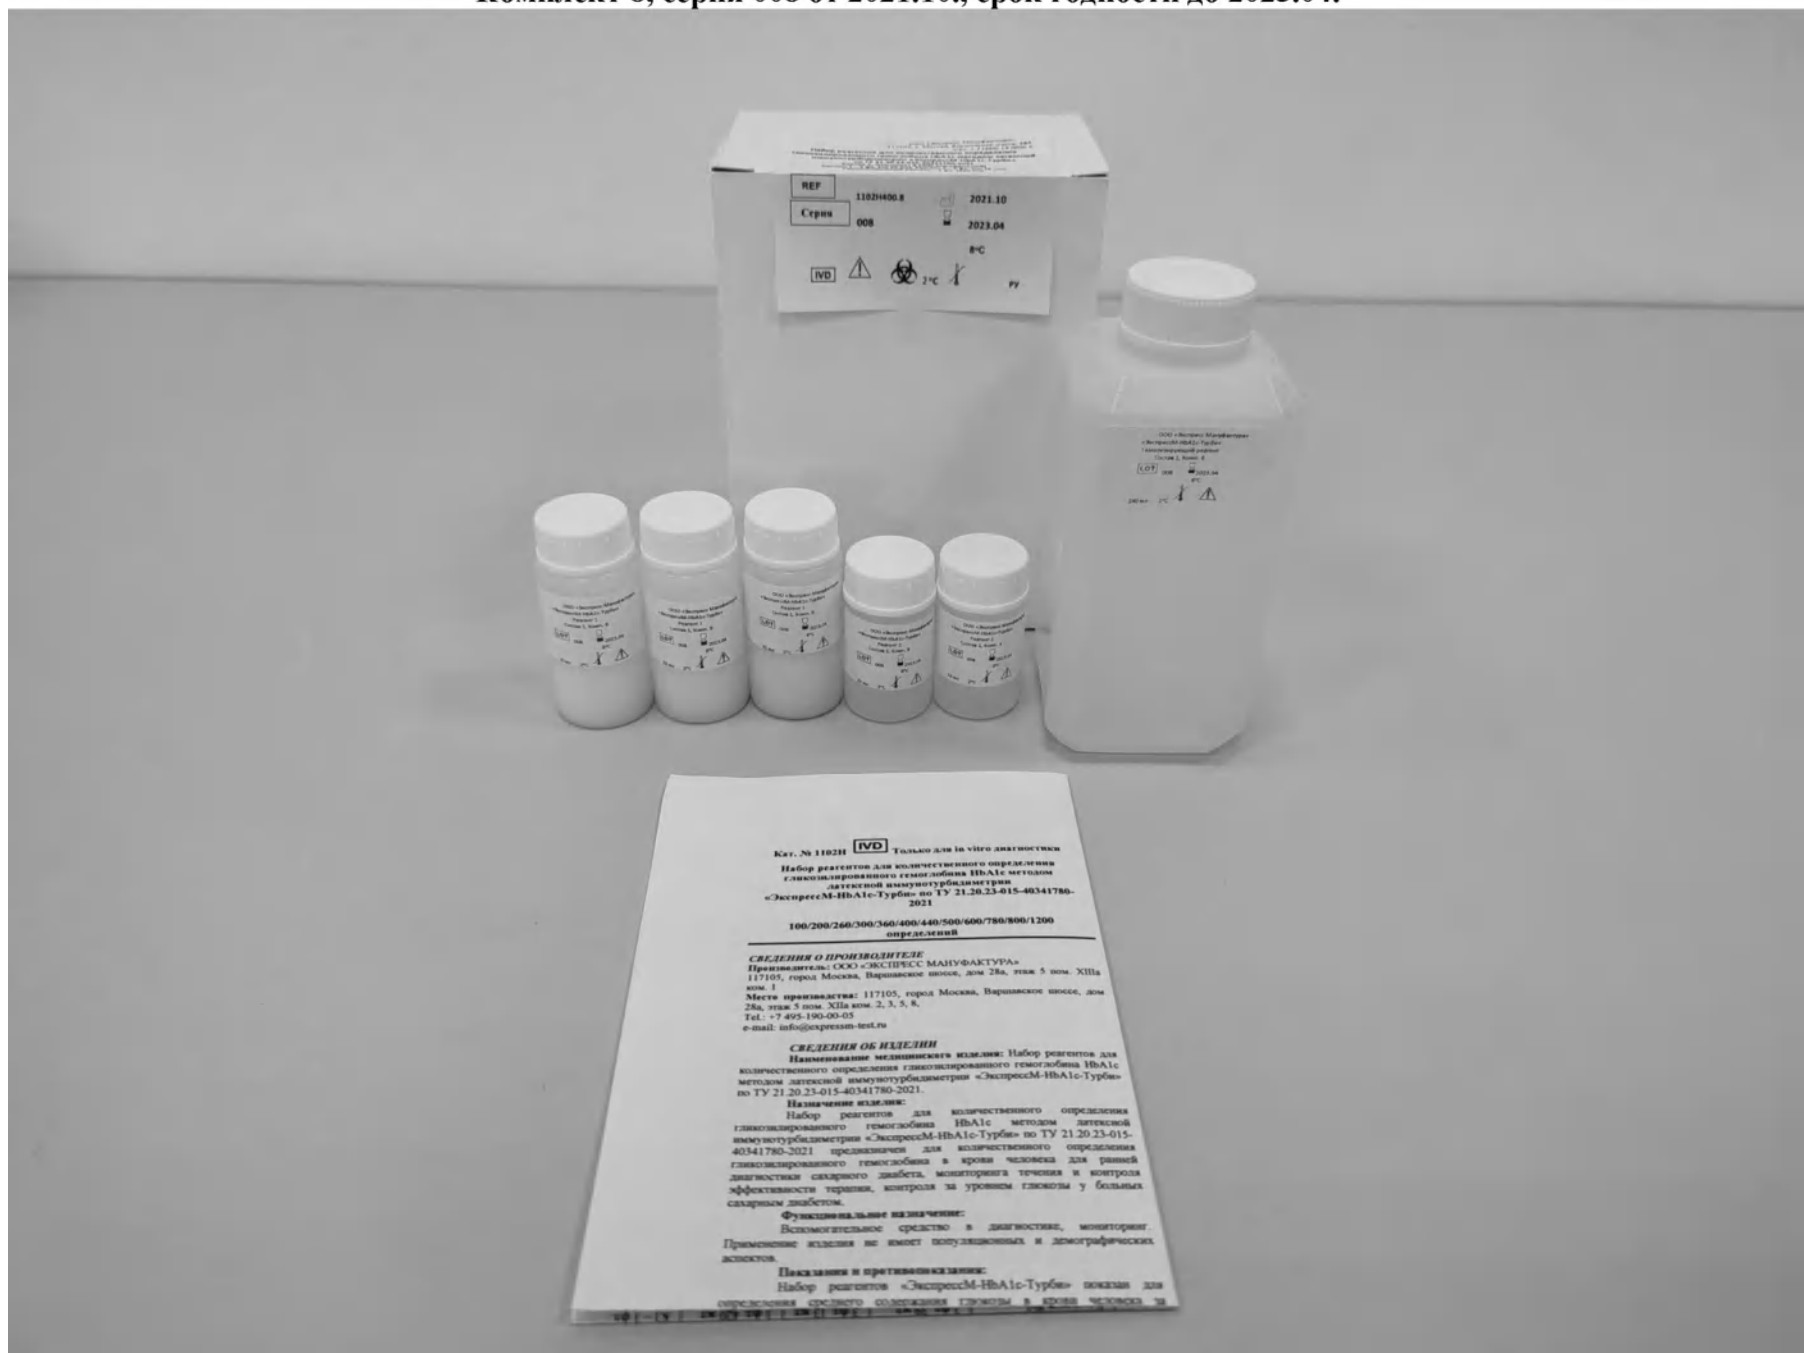

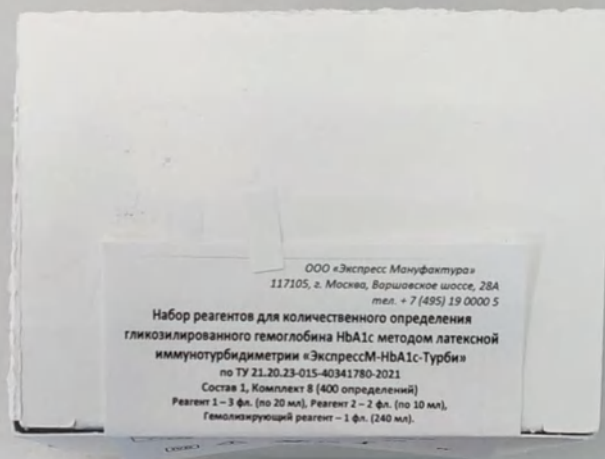

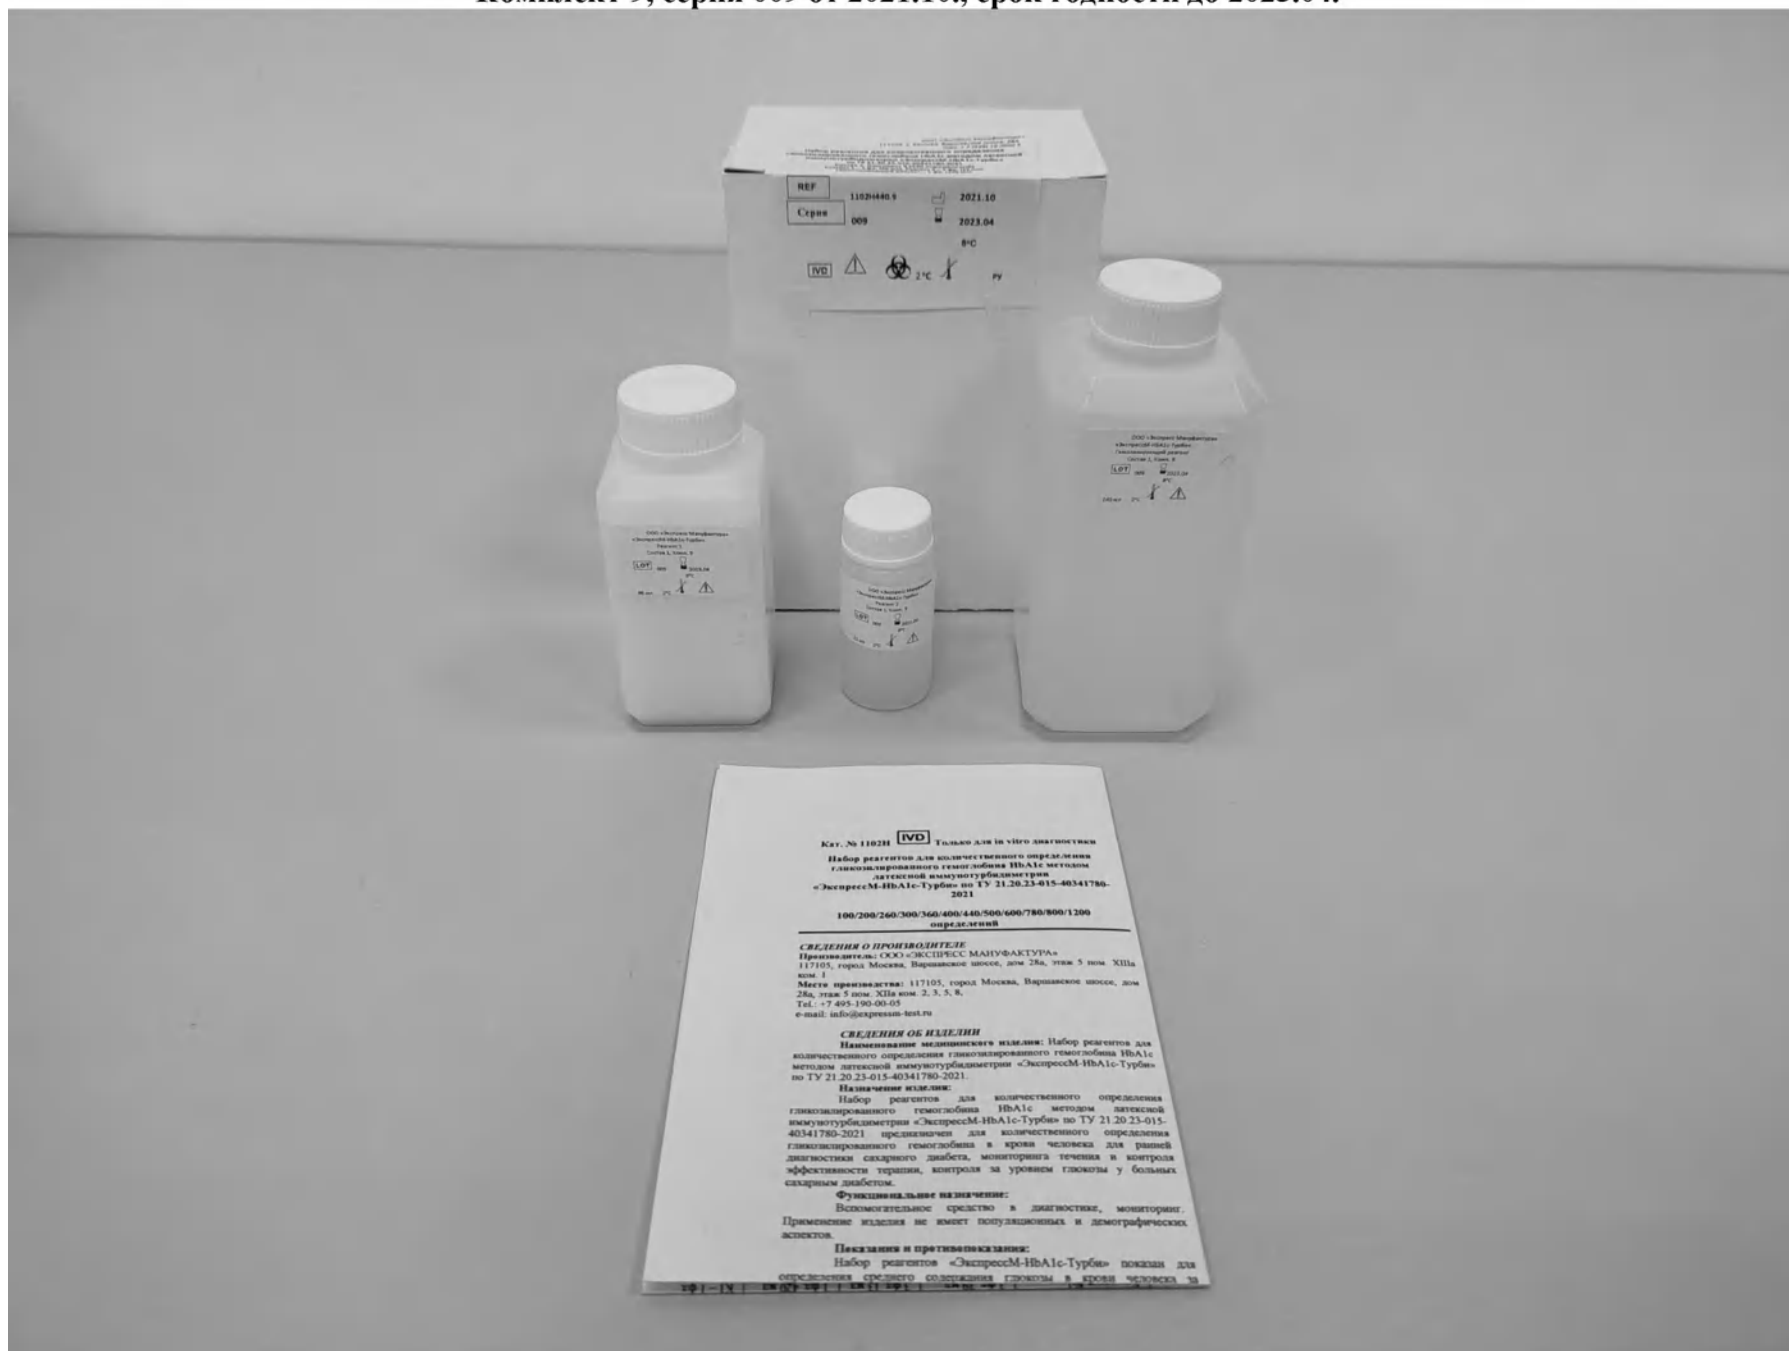






Кат. № 117105
ИД Только для лабораторного использования
Набор реагентов для количественного определения
гидролизированного гемоглобина ИФА-тестом латексной
микропробирки «Экспресс-ИФА-тесты»
по ТУ 12.023.015-00.01700-2021
Серия 1: 18-06-00000000000000000000
Результат: 1 - 0, 2 - 1, 3 - 0, 4 - 0, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 0, 8 - 0, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 0, 12 - 0, 13 - 0, 14 - 0, 15 - 0, 16 - 0, 17 - 0, 18 - 0, 19 - 0, 20 - 0, 21 - 0, 22 - 0, 23 - 0, 24 - 0, 25 - 0, 26 - 0, 27 - 0, 28 - 0, 29 - 0, 30 - 0, 31 - 0, 32 - 0, 33 - 0, 34 - 0, 35 - 0, 36 - 0, 37 - 0, 38 - 0, 39 - 0, 40 - 0, 41 - 0, 42 - 0, 43 - 0, 44 - 0, 45 - 0, 46 - 0, 47 - 0, 48 - 0, 49 - 0, 50 - 0, 51 - 0, 52 - 0, 53 - 0, 54 - 0, 55 - 0, 56 - 0, 57 - 0, 58 - 0, 59 - 0, 60 - 0, 61 - 0, 62 - 0, 63 - 0, 64 - 0, 65 - 0, 66 - 0, 67 - 0, 68 - 0, 69 - 0, 70 - 0, 71 - 0, 72 - 0, 73 - 0, 74 - 0, 75 - 0, 76 - 0, 77 - 0, 78 - 0, 79 - 0, 80 - 0, 81 - 0, 82 - 0, 83 - 0, 84 - 0, 85 - 0, 86 - 0, 87 - 0, 88 - 0, 89 - 0, 90 - 0, 91 - 0, 92 - 0, 93 - 0, 94 - 0, 95 - 0, 96 - 0, 97 - 0, 98 - 0, 99 - 0, 100 - 0

СЕРТИФИКАТ
ООО «Эксперт-МедиаГруппа»
117105, г. Москва, Вулканский шоссе, 28А
Тел. +7 (495) 19 0000 5
Факс +7 (495) 19 0000 6
E-mail: info@expert-media.ru
Сайт: www.expert-media.ru
Серия 1: 18-06-00000000000000000000
Результат: 1 - 0, 2 - 1, 3 - 0, 4 - 0, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 0, 8 - 0, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 0, 12 - 0, 13 - 0, 14 - 0, 15 - 0, 16 - 0, 17 - 0, 18 - 0, 19 - 0, 20 - 0, 21 - 0, 22 - 0, 23 - 0, 24 - 0, 25 - 0, 26 - 0, 27 - 0, 28 - 0, 29 - 0, 30 - 0, 31 - 0, 32 - 0, 33 - 0, 34 - 0, 35 - 0, 36 - 0, 37 - 0, 38 - 0, 39 - 0, 40 - 0, 41 - 0, 42 - 0, 43 - 0, 44 - 0, 45 - 0, 46 - 0, 47 - 0, 48 - 0, 49 - 0, 50 - 0, 51 - 0, 52 - 0, 53 - 0, 54 - 0, 55 - 0, 56 - 0, 57 - 0, 58 - 0, 59 - 0, 60 - 0, 61 - 0, 62 - 0, 63 - 0, 64 - 0, 65 - 0, 66 - 0, 67 - 0, 68 - 0, 69 - 0, 70 - 0, 71 - 0, 72 - 0, 73 - 0, 74 - 0, 75 - 0, 76 - 0, 77 - 0, 78 - 0, 79 - 0, 80 - 0, 81 - 0, 82 - 0, 83 - 0, 84 - 0, 85 - 0, 86 - 0, 87 - 0, 88 - 0, 89 - 0, 90 - 0, 91 - 0, 92 - 0, 93 - 0, 94 - 0, 95 - 0, 96 - 0, 97 - 0, 98 - 0, 99 - 0, 100 - 0

СЕРТИФИКАТ
ООО «Эксперт-МедиаГруппа»
117105, г. Москва, Вулканский шоссе, 28А
Тел. +7 (495) 19 0000 5
Факс +7 (495) 19 0000 6
E-mail: info@expert-media.ru
Сайт: www.expert-media.ru
Серия 1: 18-06-00000000000000000000
Результат: 1 - 0, 2 - 1, 3 - 0, 4 - 0, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 0, 8 - 0, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 0, 12 - 0, 13 - 0, 14 - 0, 15 - 0, 16 - 0, 17 - 0, 18 - 0, 19 - 0, 20 - 0, 21 - 0, 22 - 0, 23 - 0, 24 - 0, 25 - 0, 26 - 0, 27 - 0, 28 - 0, 29 - 0, 30 - 0, 31 - 0, 32 - 0, 33 - 0, 34 - 0, 35 - 0, 36 - 0, 37 - 0, 38 - 0, 39 - 0, 40 - 0, 41 - 0, 42 - 0, 43 - 0, 44 - 0, 45 - 0, 46 - 0, 47 - 0, 48 - 0, 49 - 0, 50 - 0, 51 - 0, 52 - 0, 53 - 0, 54 - 0, 55 - 0, 56 - 0, 57 - 0, 58 - 0, 59 - 0, 60 - 0, 61 - 0, 62 - 0, 63 - 0, 64 - 0, 65 - 0, 66 - 0, 67 - 0, 68 - 0, 69 - 0, 70 - 0, 71 - 0, 72 - 0, 73 - 0, 74 - 0, 75 - 0, 76 - 0, 77 - 0, 78 - 0, 79 - 0, 80 - 0, 81 - 0, 82 - 0, 83 - 0, 84 - 0, 85 - 0, 86 - 0, 87 - 0, 88 - 0, 89 - 0, 90 - 0, 91 - 0, 92 - 0, 93 - 0, 94 - 0, 95 - 0, 96 - 0, 97 - 0, 98 - 0, 99 - 0, 100 - 0

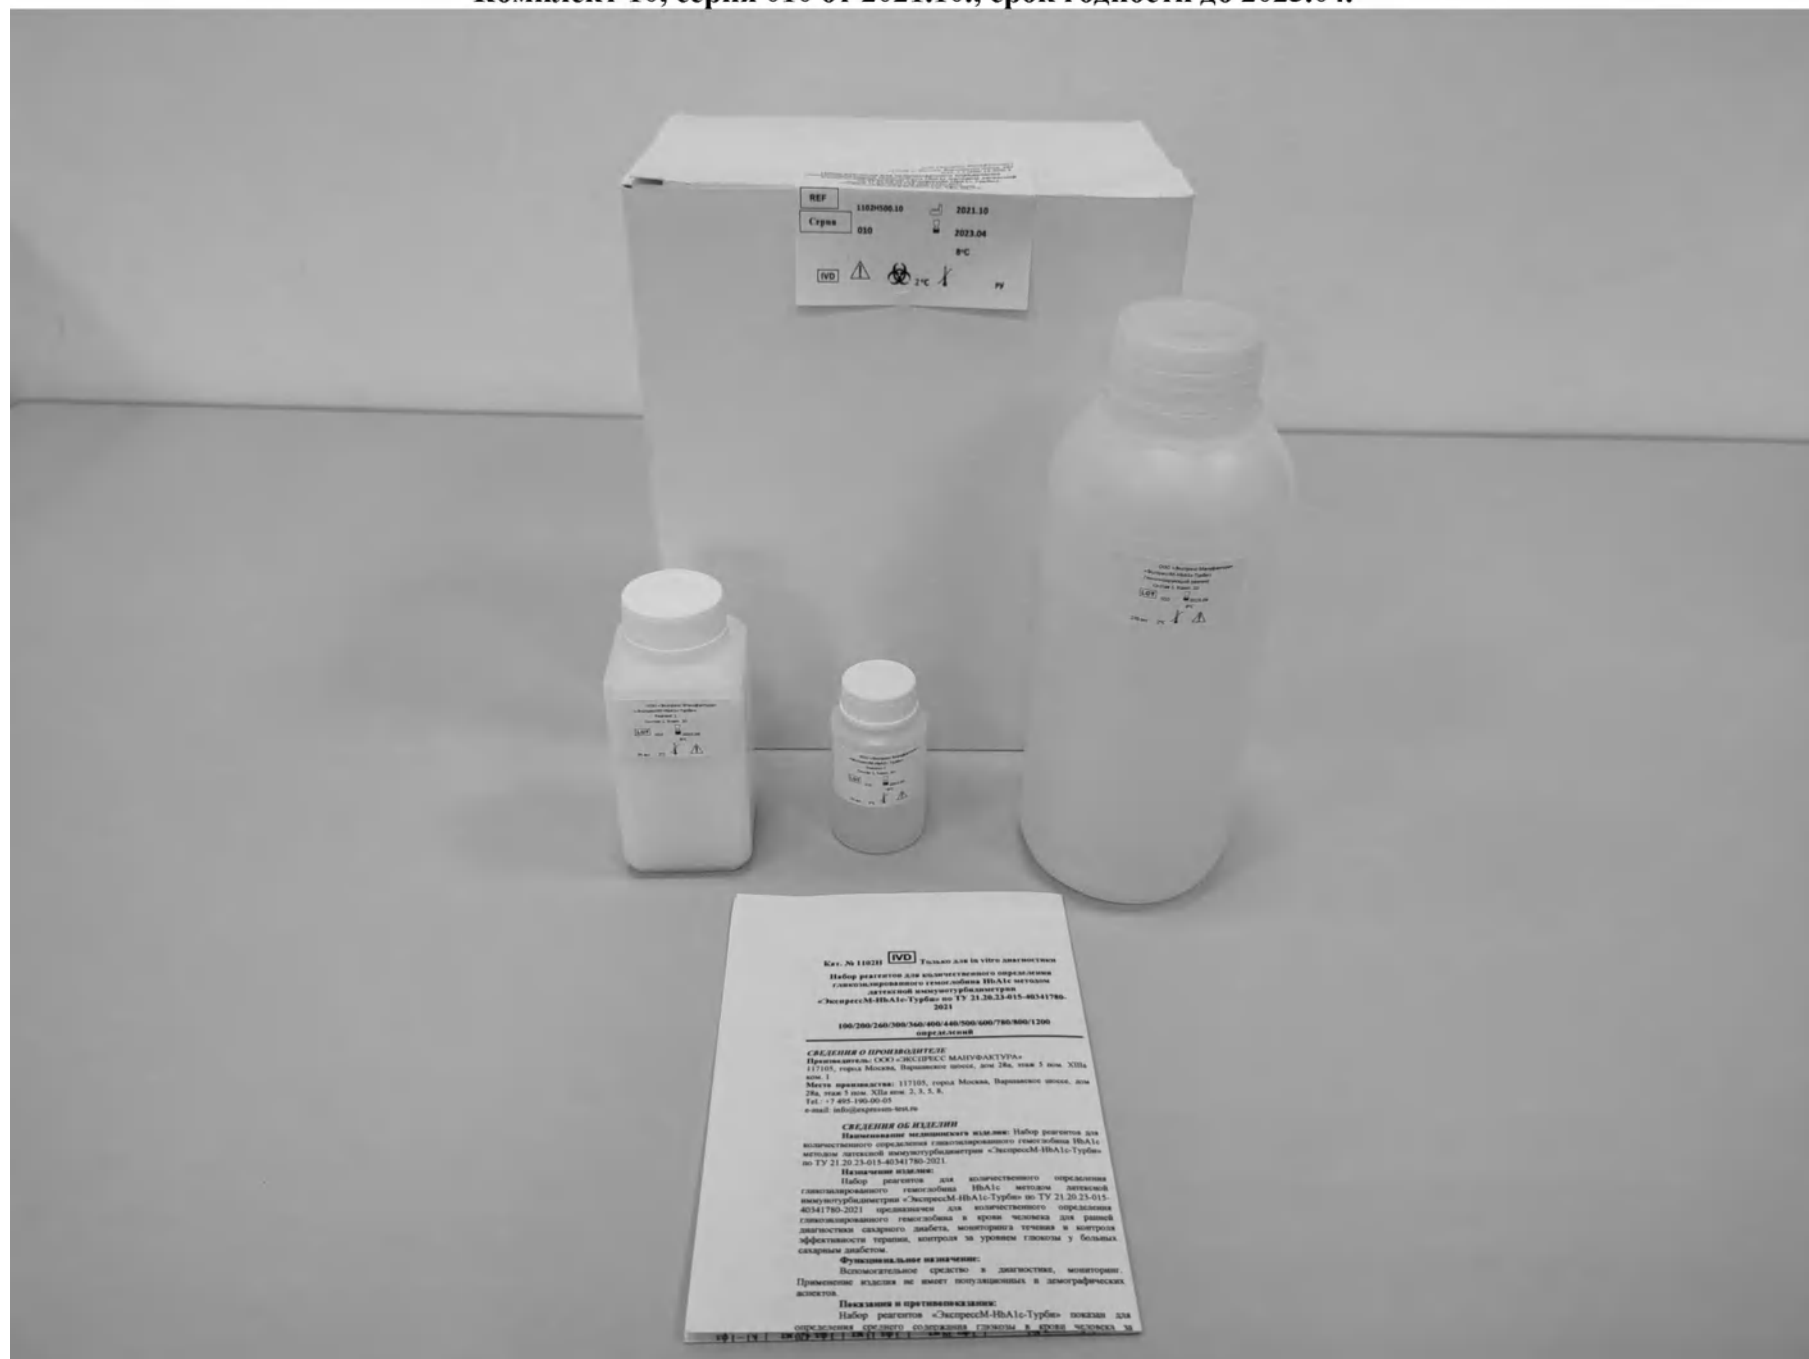


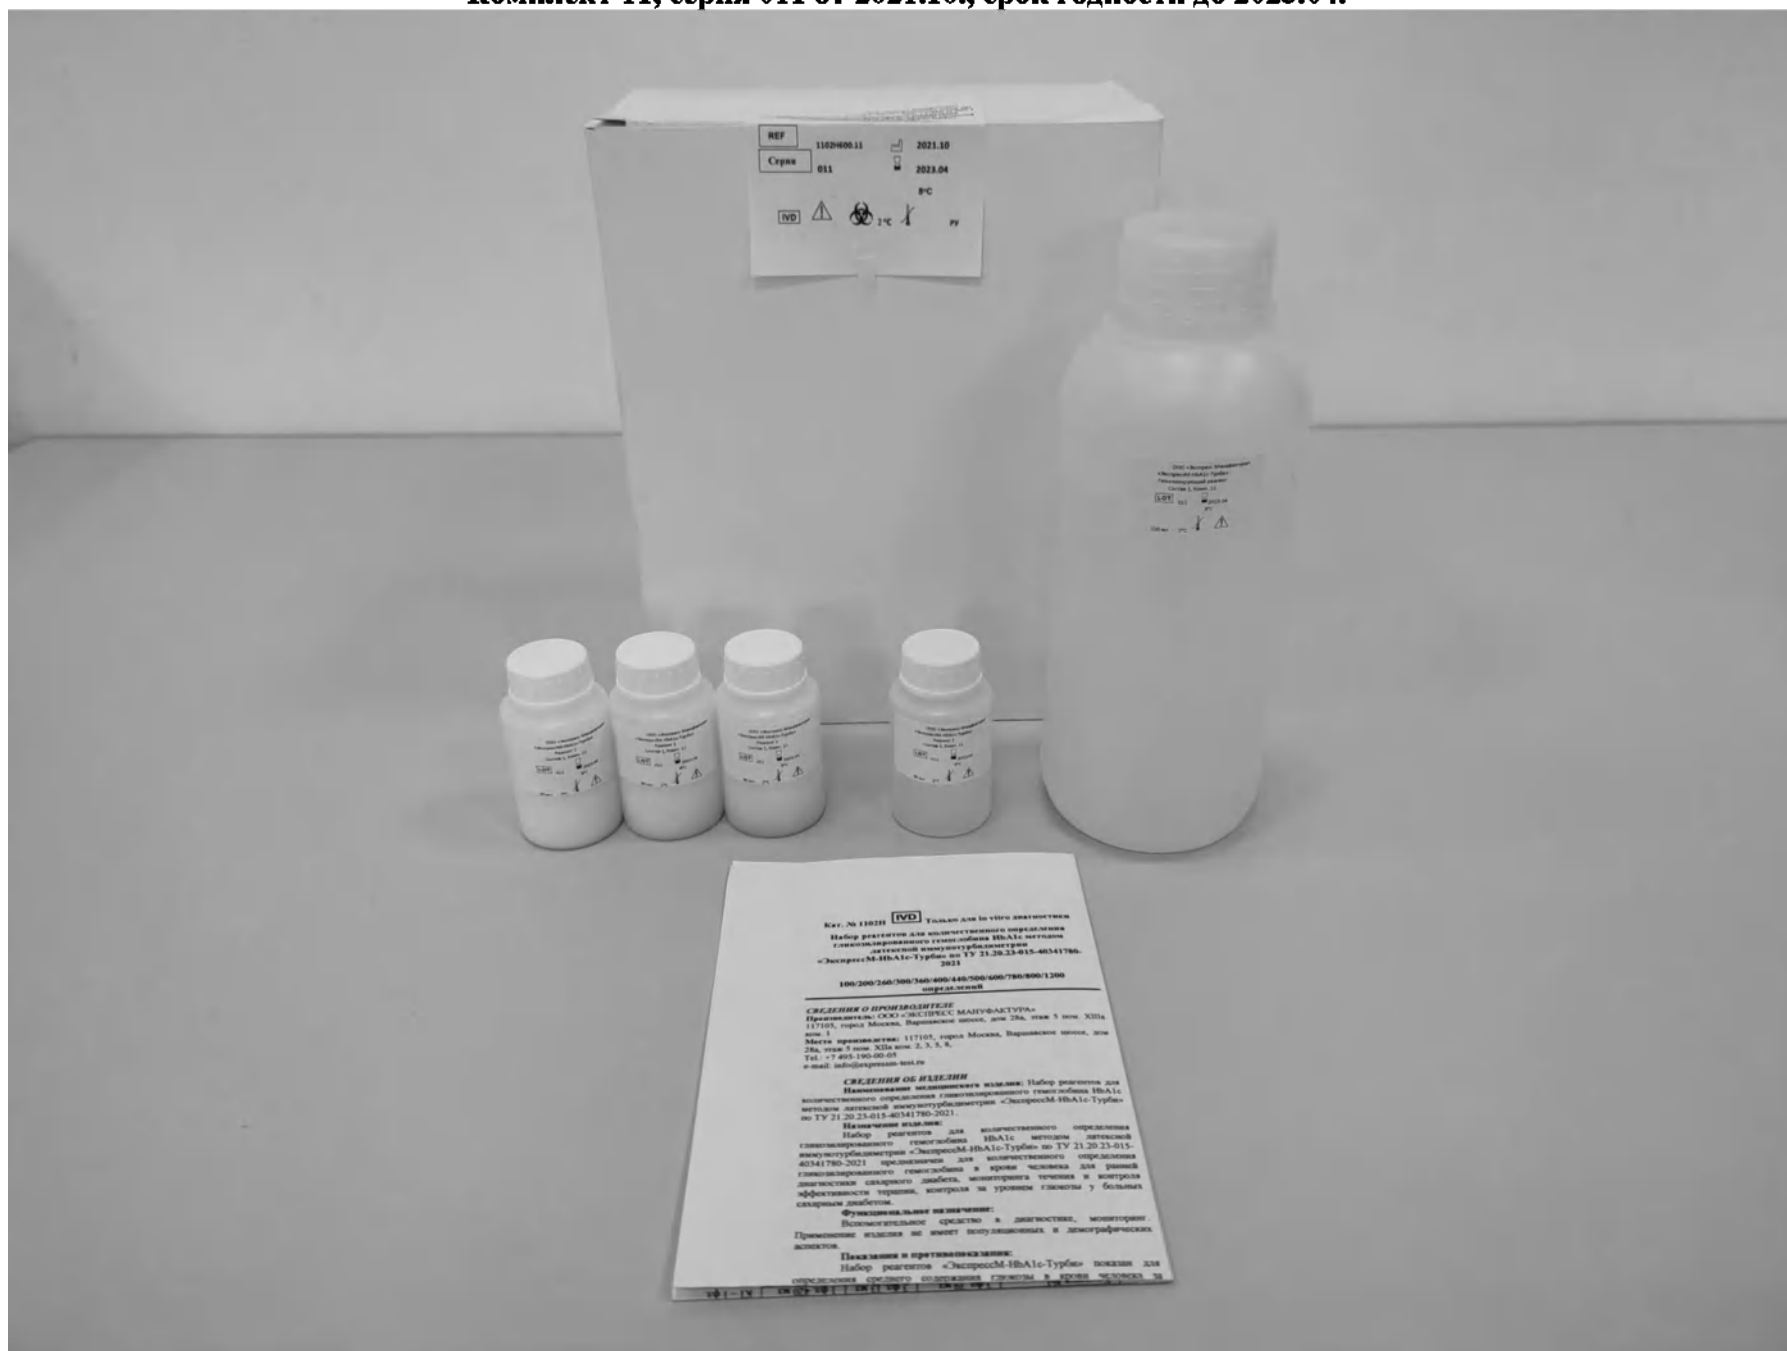


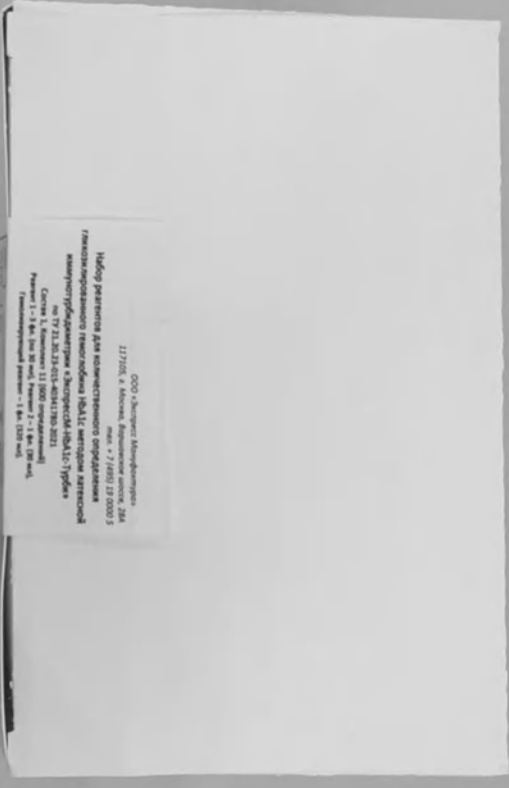



№1. № 1 (001) **ИБЛ** Пленка для микропористой пленки
Индокс предназначен для дезинфекции поверхностей
гидрофобизированной резиновой пленкой ИБЛ-1с, вершины
микропористой пленки «Экспресс-ИБЛ-1с»
ИЗДАНИЕ 01.04.2019 №01
Серия 1. Количество 120 штук
Пакет 1 - 8 шт. Пакет 2 - 1 шт. 120 шт.
Гидрофобизированная пленка - 1 шт. 120 шт.


ООО "Центрум Биофармация"
117105, г. Москва, Боровицкий проезд, 28А
тел. +7 (495) 23 0000 5
Индокс предназначен для дезинфекции поверхностей
гидрофобизированной резиновой пленкой ИБЛ-1с, вершины
микропористой пленки «Экспресс-ИБЛ-1с»
ИЗДАНИЕ 01.04.2019 №01
Серия 1. Количество 120 штук
Пакет 1 - 8 шт. Пакет 2 - 1 шт. 120 шт.
Гидрофобизированная пленка - 1 шт. 120 шт.


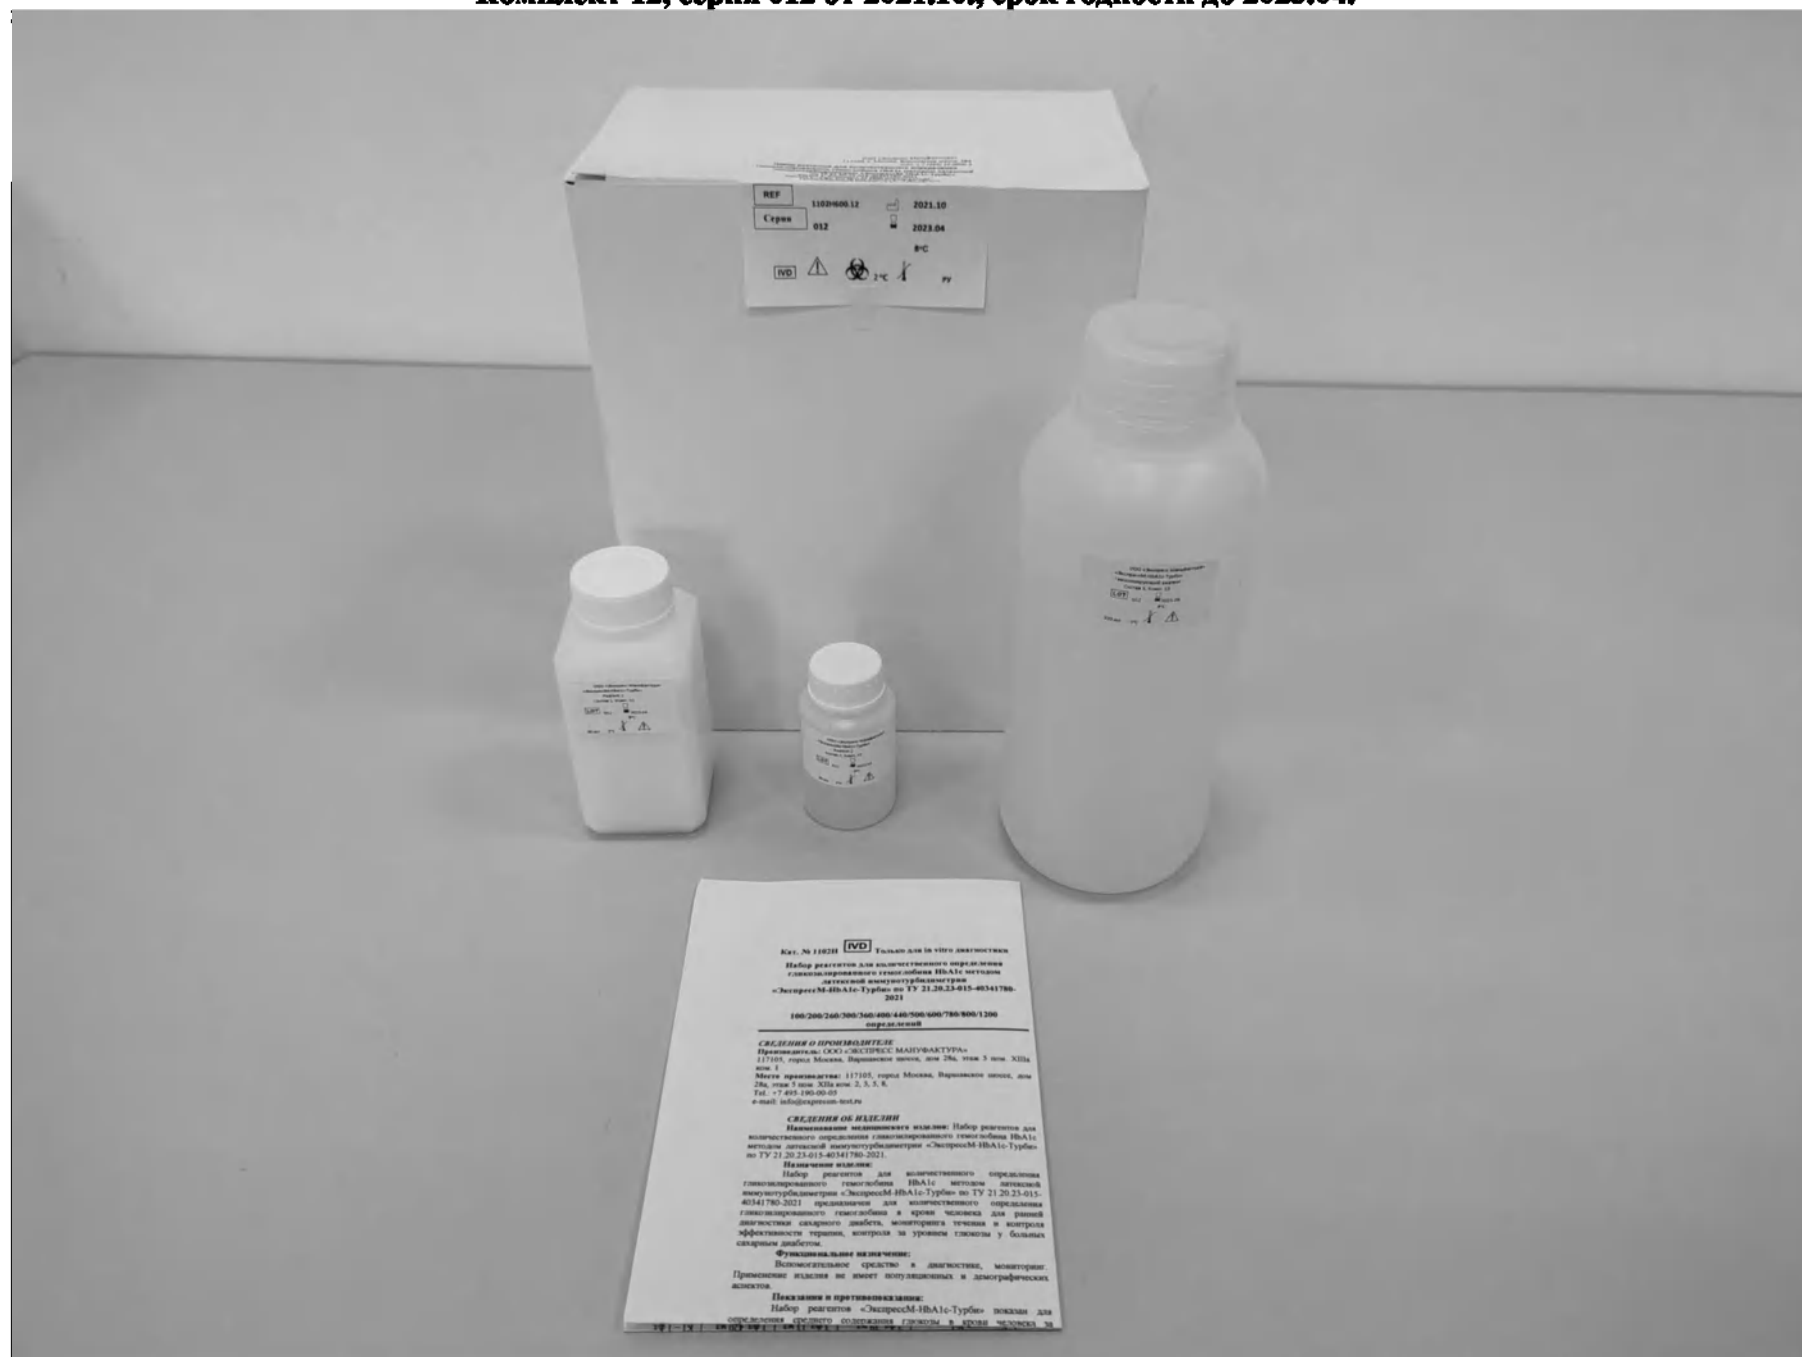


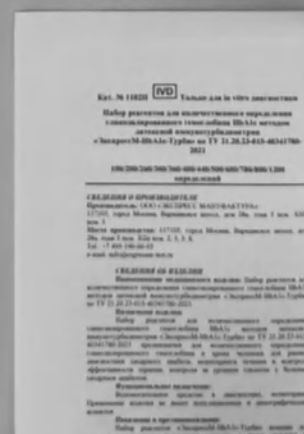

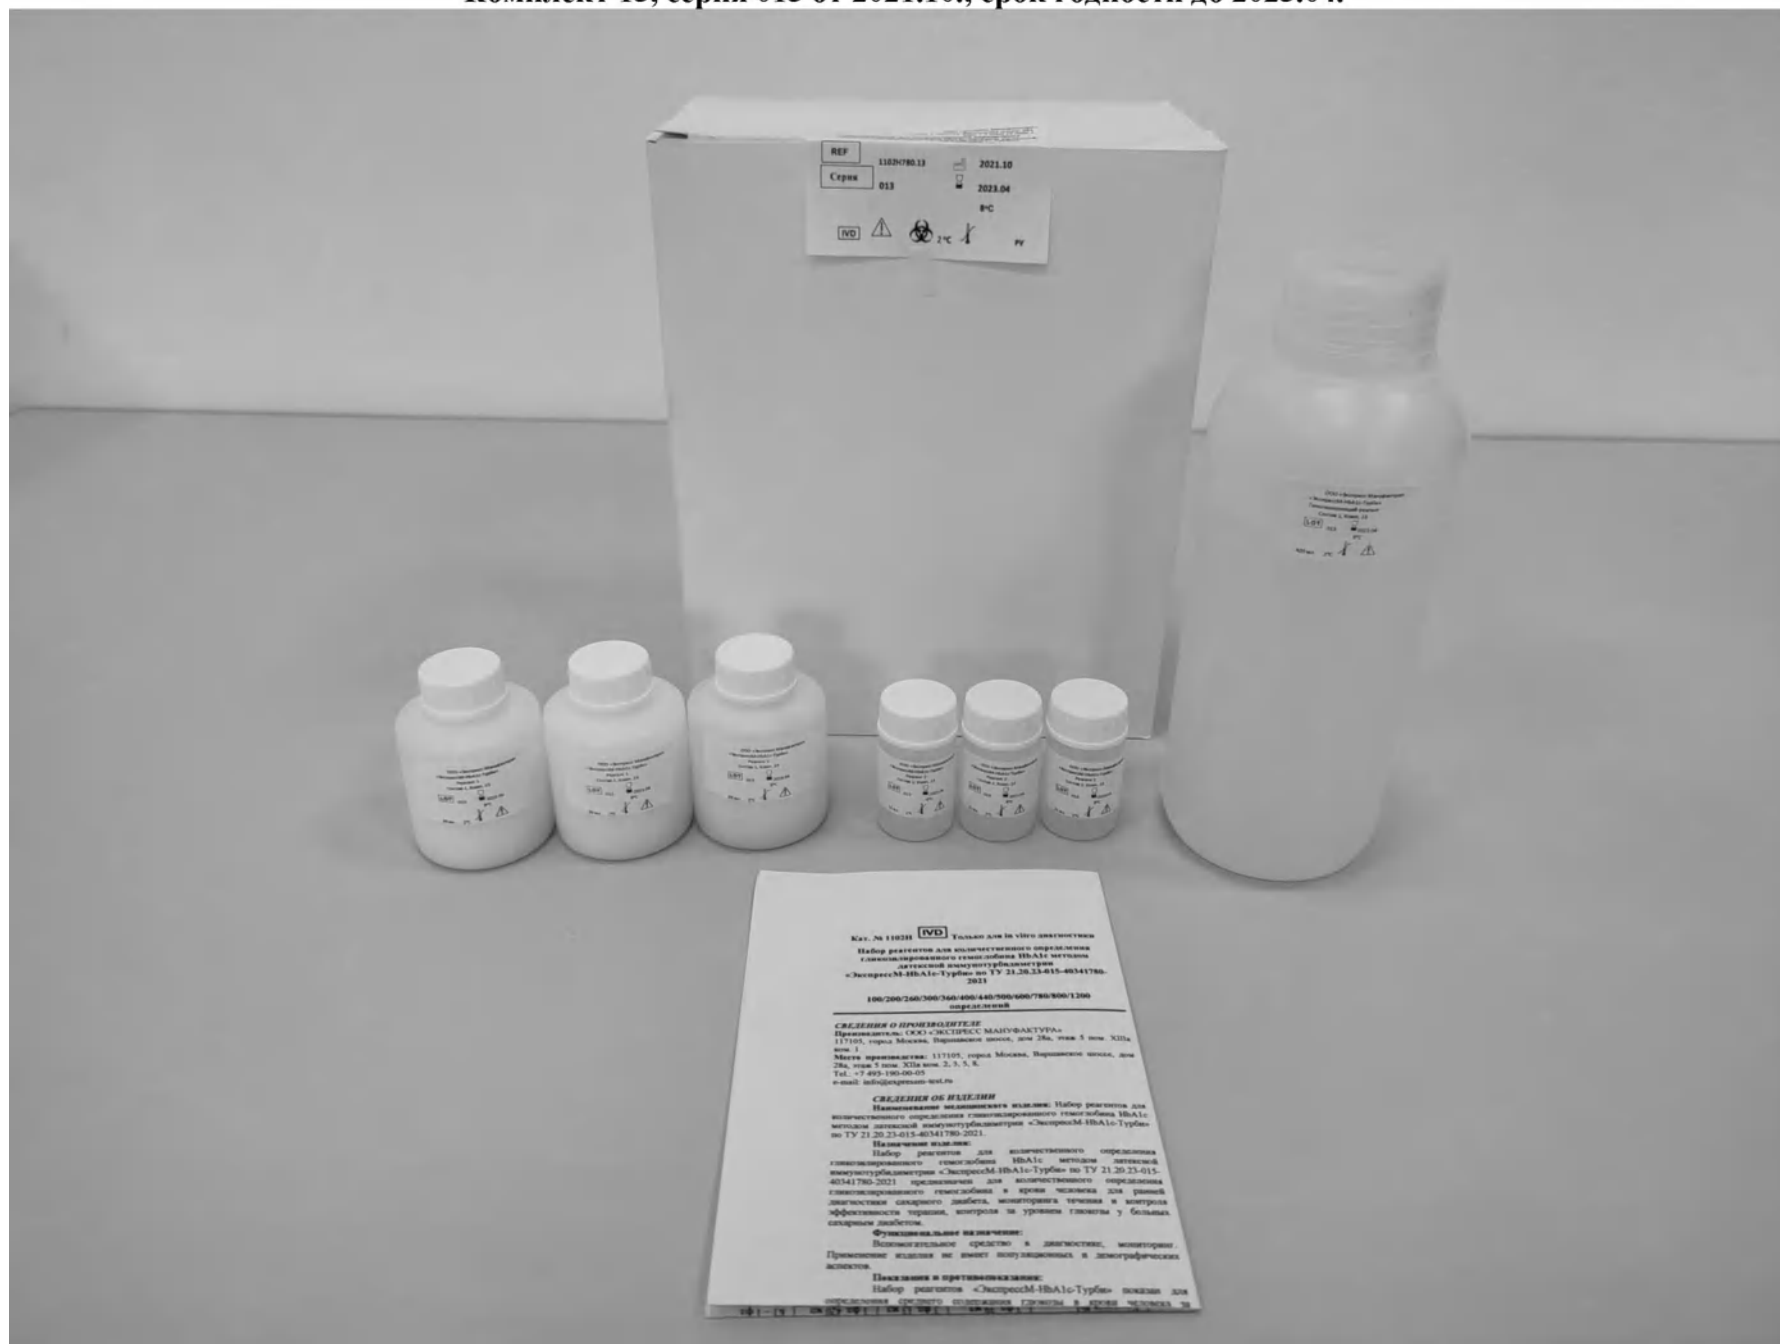



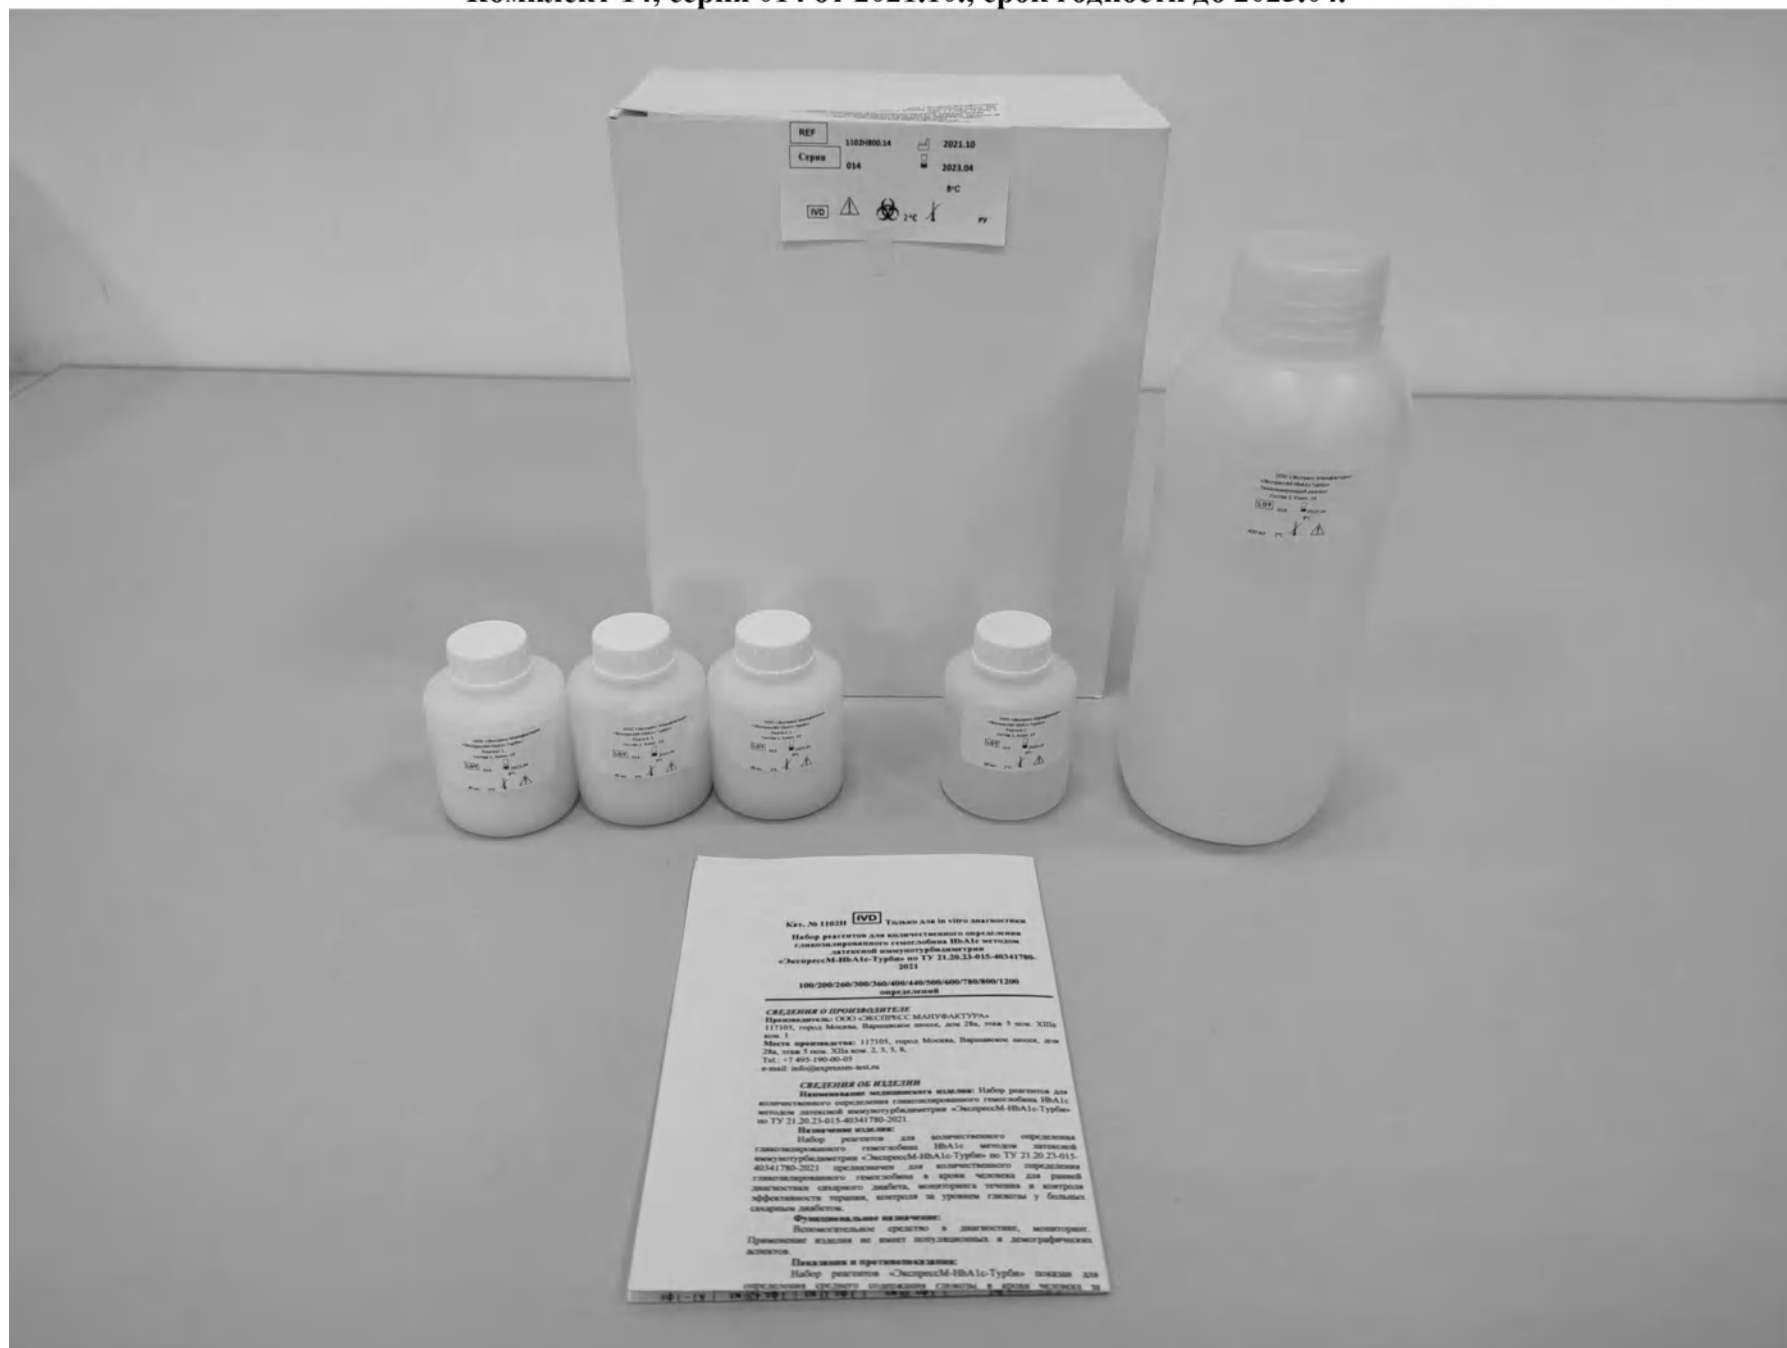


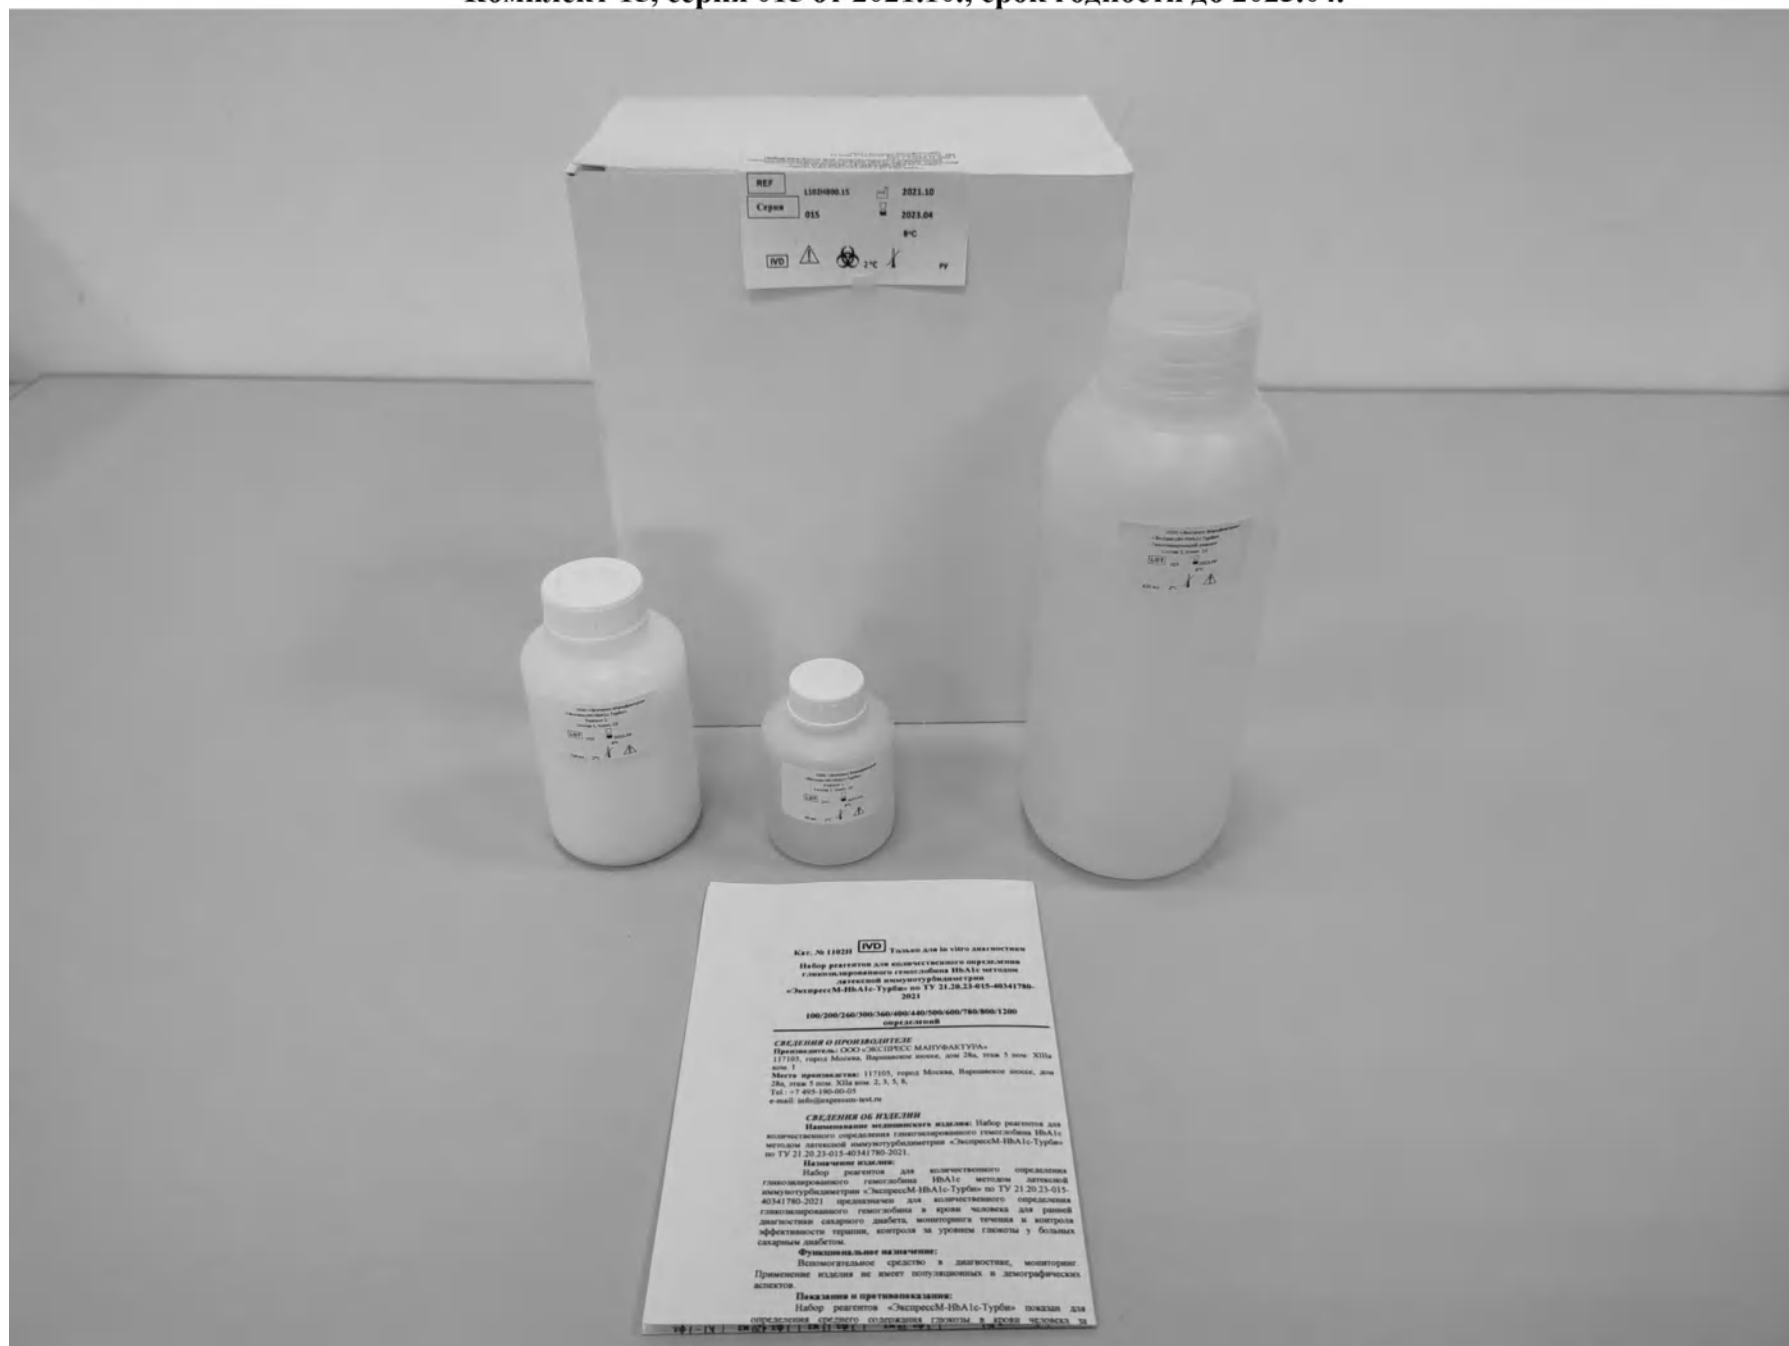

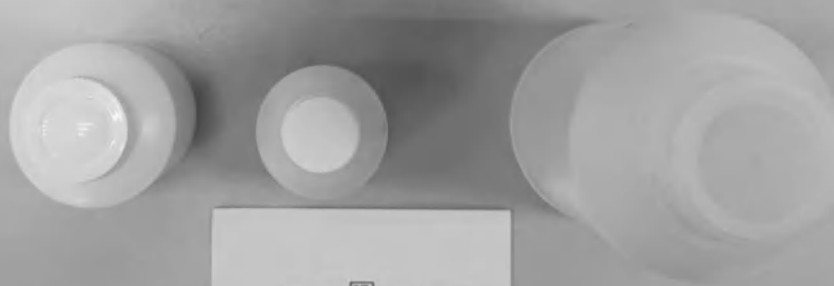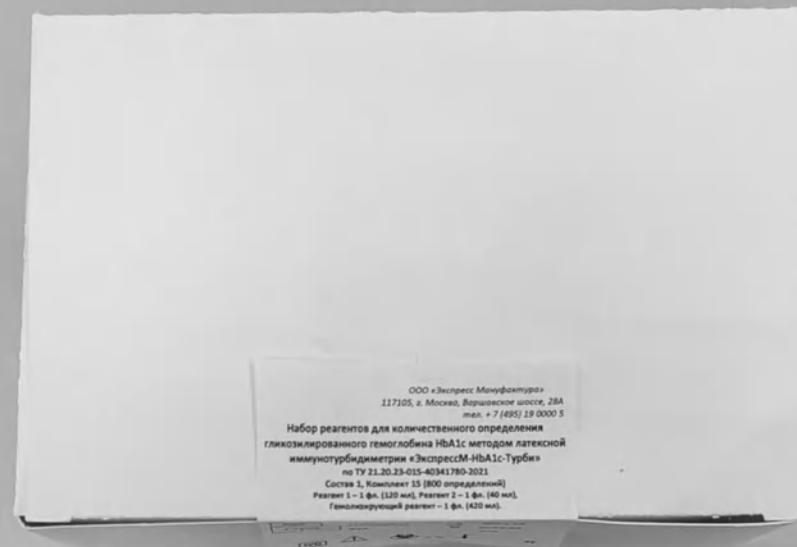



Кат. № 11828 **IVD** только для in vitro диагностики
 Набор реагентов для количественного определения
 гликозилированного гемоглобина HbA1c методом
 латексной иммунотурбидиметрии
 «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-
 2021
 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
 мг/дл, ммоль/л
СРЕДСТВО ОДНОРАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
 Наименование: «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби»
 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, этаж 1 пом. 5/10
 пом. 5
 Место производства: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, этаж 1 пом. 5/10 пом. 5, 1, 5, 6
 Тел. +7 495 190 00 00
 e-mail: info@express-m.ru
Составление и выпуск
 Составление: разработана компания. Набор реагентов для
 количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA1c
 методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби»
 по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021.
Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения
 гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной
 иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби» по ТУ 21.20.23-015-
 40341780-2021 предназначен для количественного определения
 гликозилированного гемоглобина в крови человека для ранней
 диагностики сахарного диабета, контроля лечения и оценки
 эффективности терапии, контроля за уровнем гликемии у больных
 сахарным диабетом.
Упаковка и количество:
 Упаковочные материалы – пластик, картон.
 Приспособление: набор из пяти флаконов и дозатора.
Назначение и применение:
 Набор реагентов «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби» можно использовать
 для количественного определения гликозилированного гемоглобина в

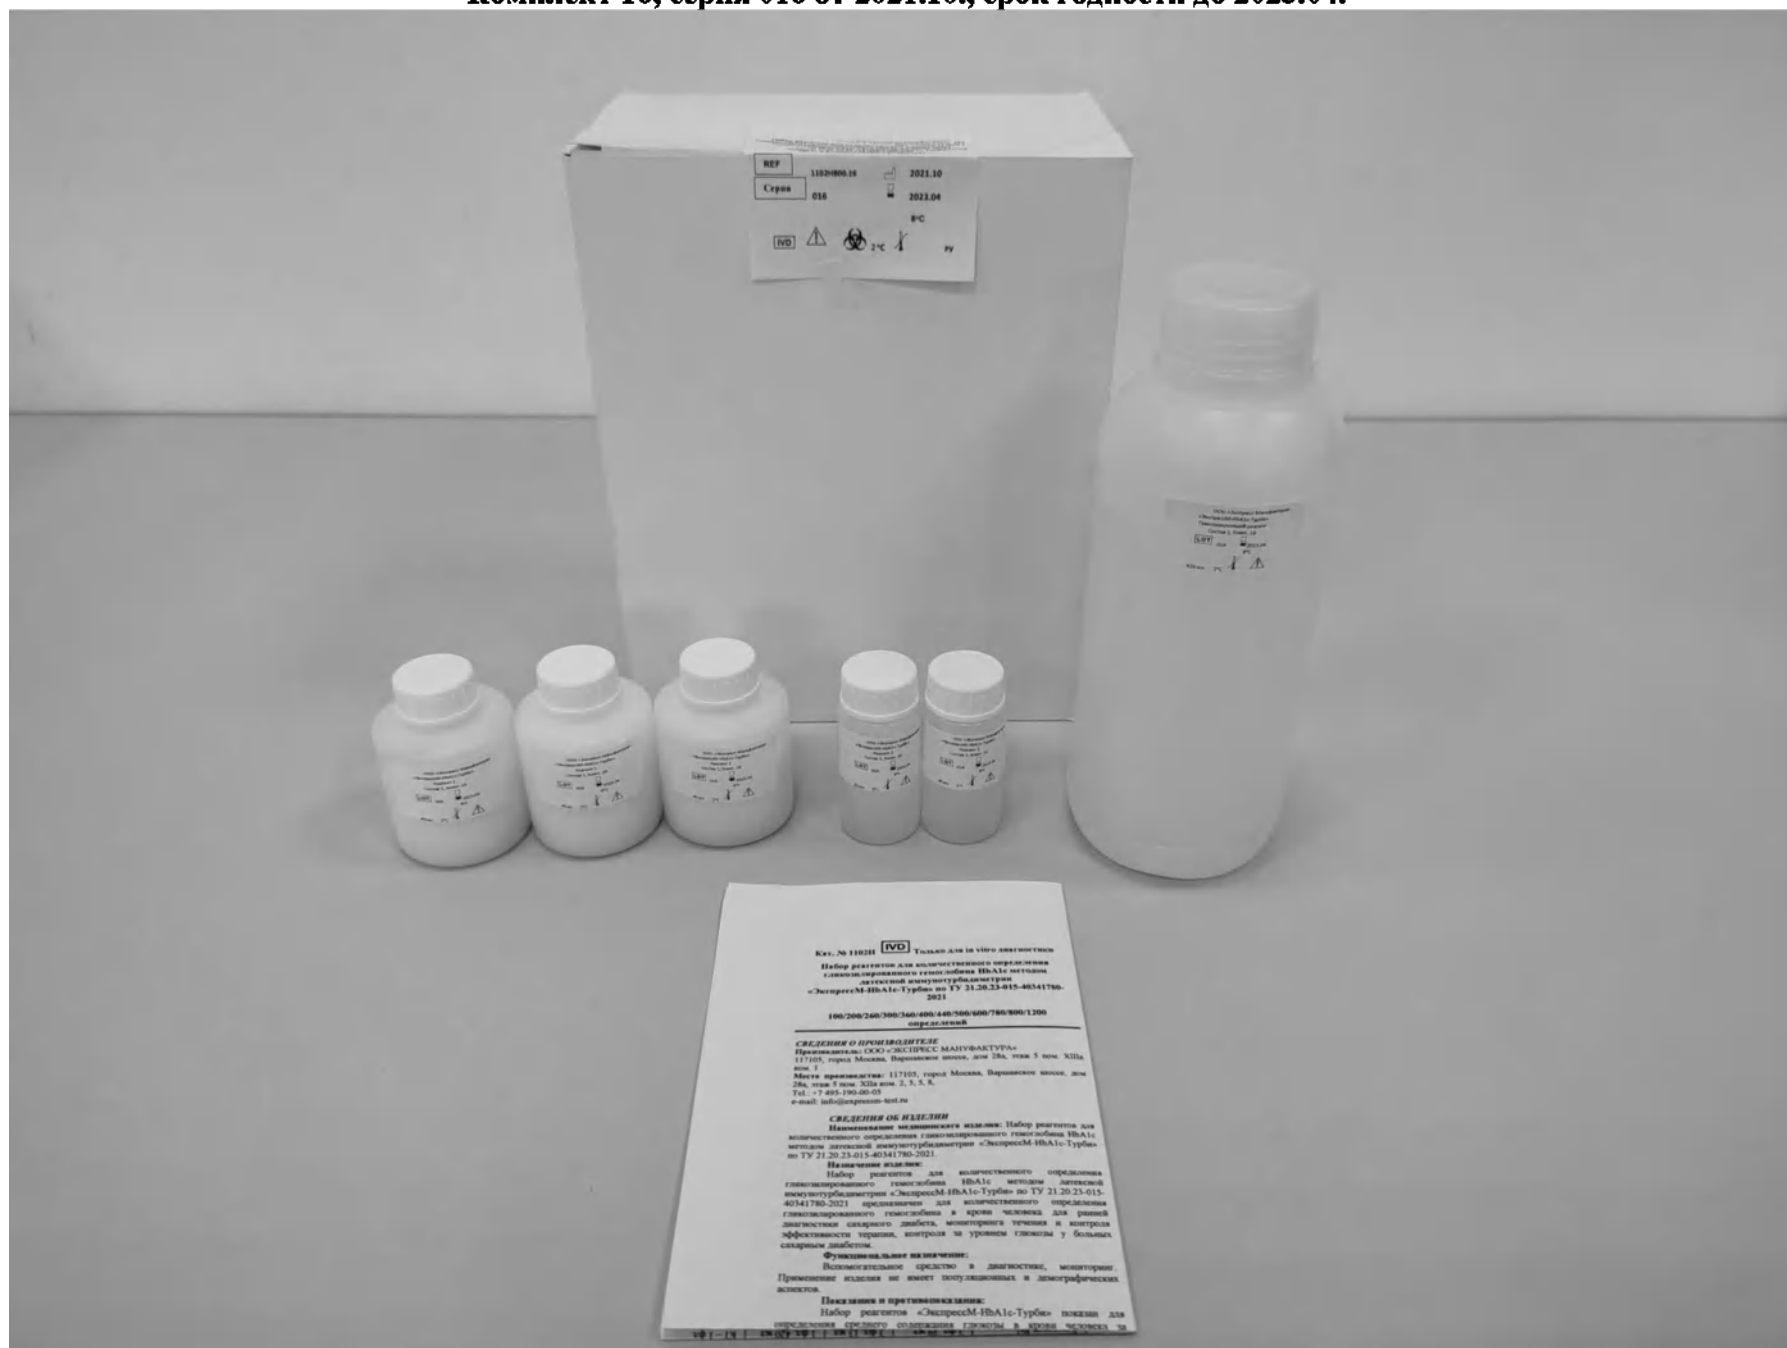

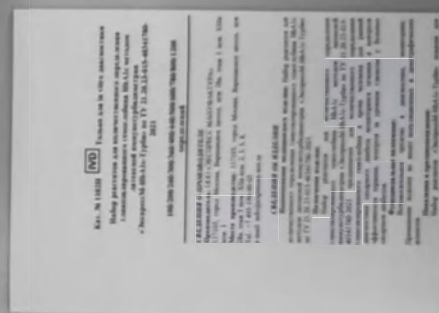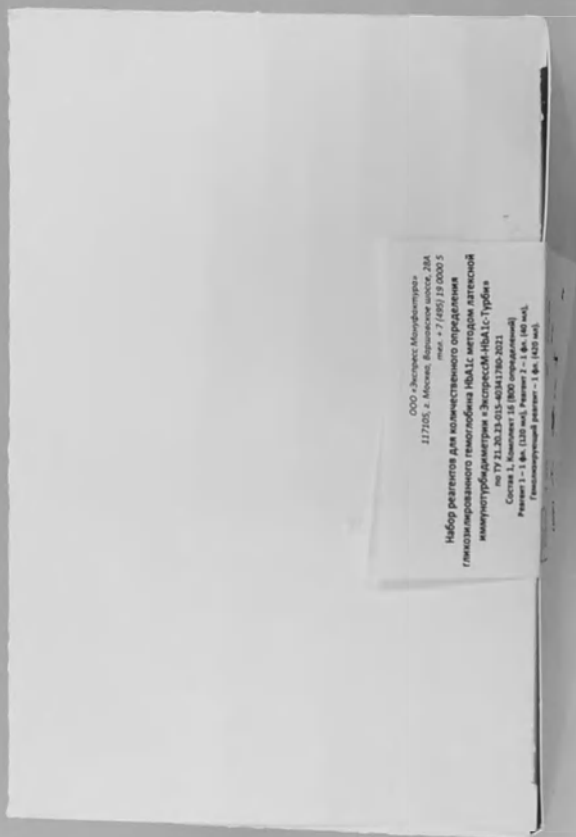

Состав 2
Состав 1 Комплект 1, серия 017 от 2021.10., срок годности до 2023.04.

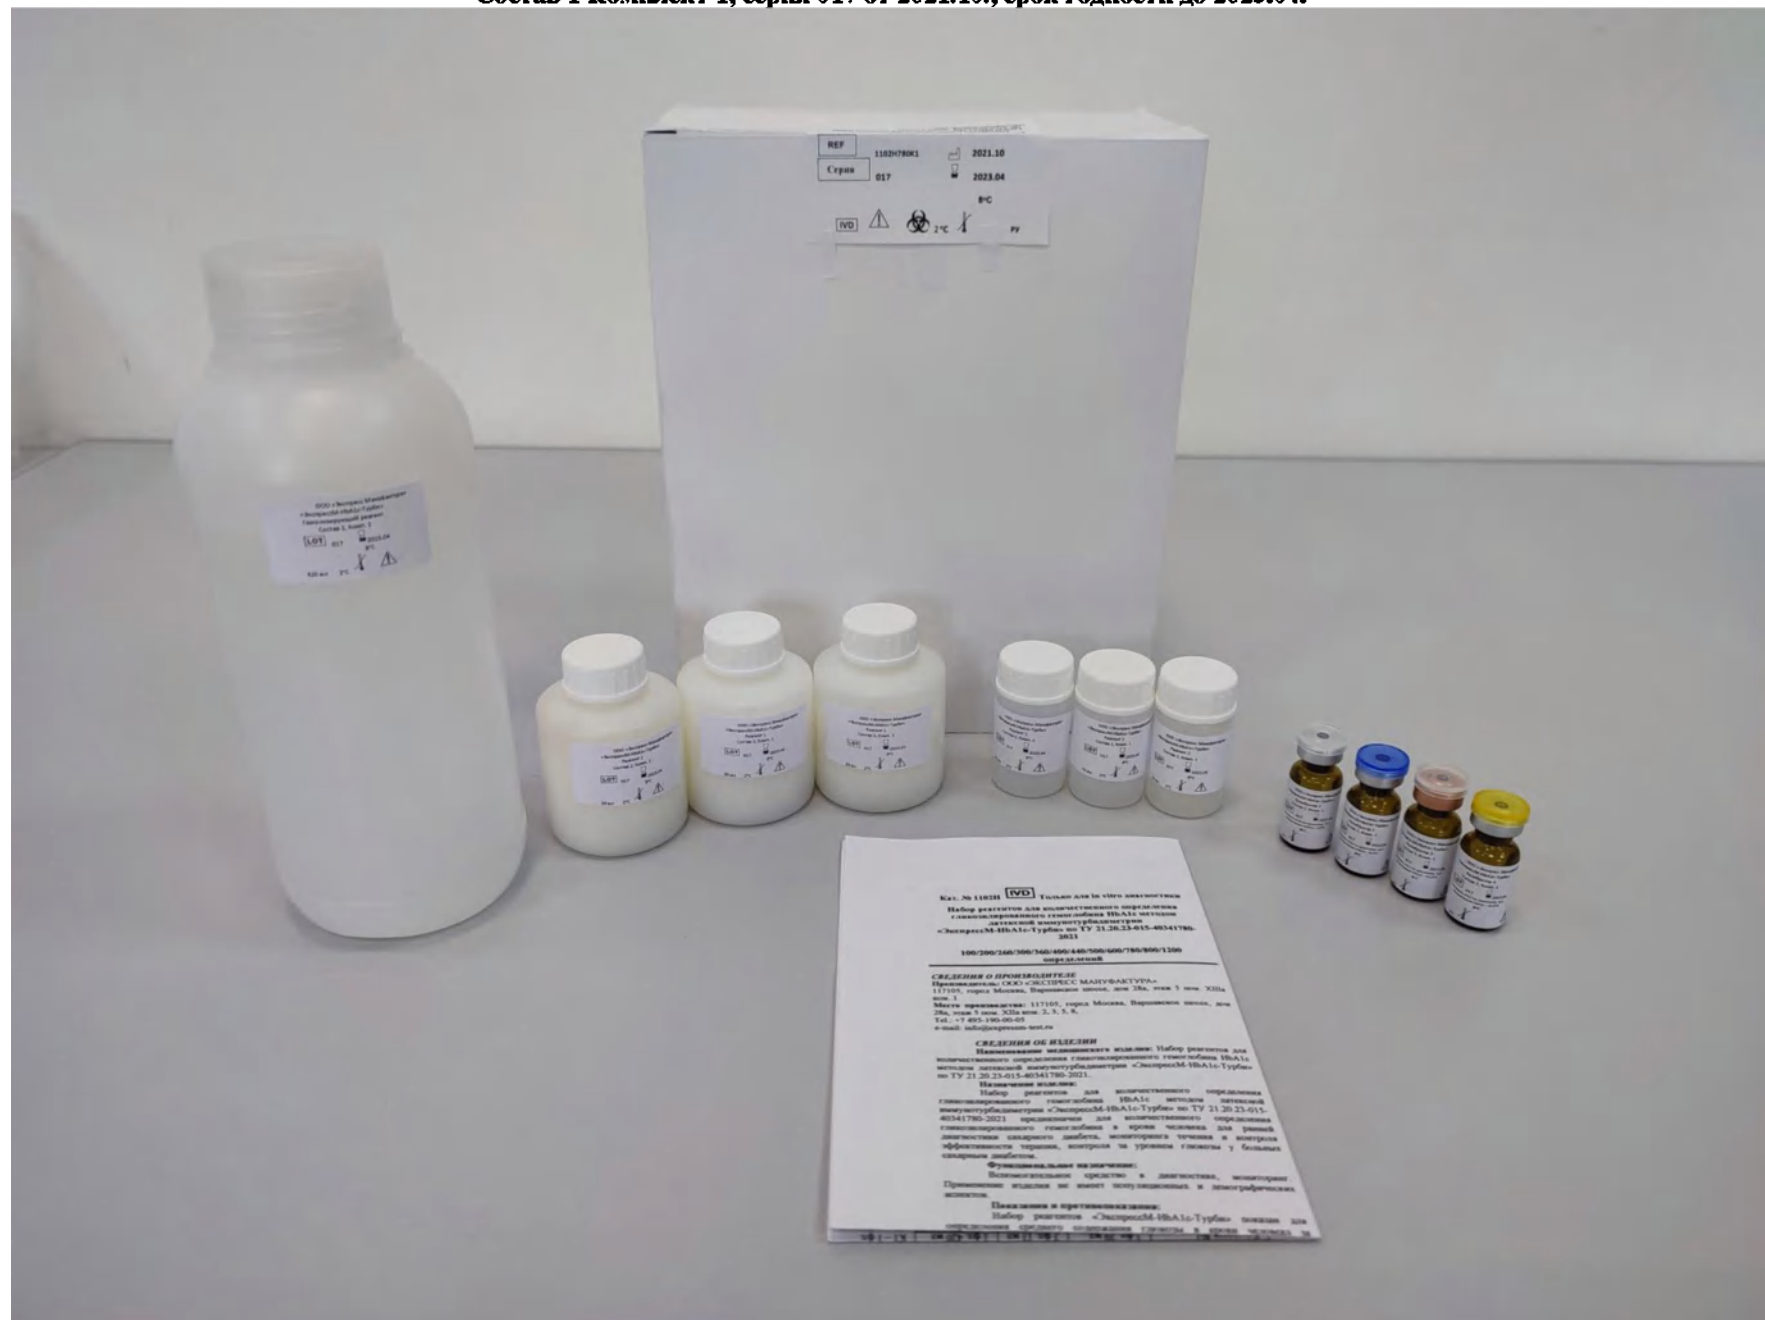


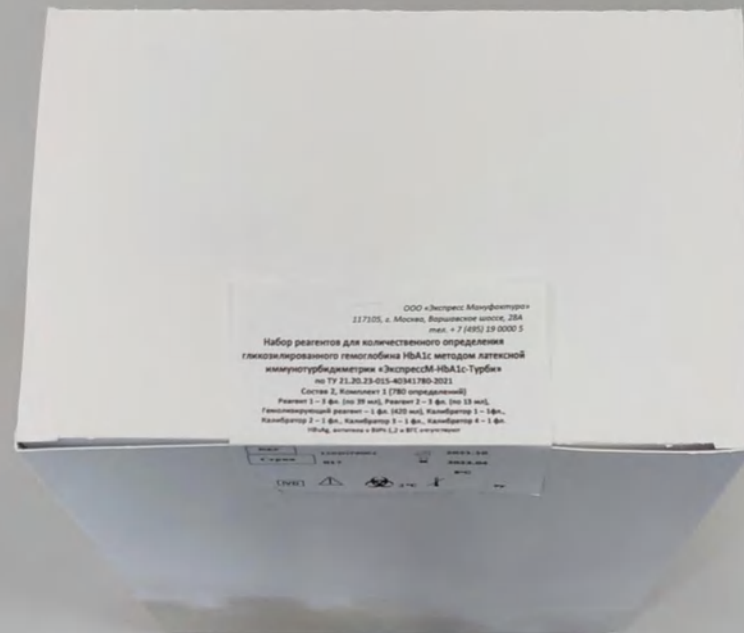




Кат. № 11628 **IVD** Только для in vitro диагностики
 Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина НВА1с методом латексной иммуноагглютинации «Экспресс М-НВА1с-Турби» по ТУ 21.28.23-015-00341780-2021
 190/290/760/760/400/400/500/400/780/800/1200 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»
 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, этаж 1 пом. 3/010
 Место производства: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, этаж 1 пом. 3/010
 Тел.: +7 495 190-00-01
 e-mail: info@expres-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина НВА1с методом латексной иммуноагглютинации «Экспресс М-НВА1с-Турби» по ТУ 21.28.23-015-00341780-2021
 Наименование изделия:
 Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина НВА1с методом латексной иммуноагглютинации «Экспресс М-НВА1с-Турби» по ТУ 21.28.23-015-00341780-2021 предназначен для количественного определения гликозилированного гемоглобина в крови человека для ранней диагностики сахарного диабета, мониторинга течения и контроля эффективности терапии, контроля за уровнем гемоглобина у больных сахарным диабетом.
 Вспомогательные материалы:
 Изготовлены из пластика и пластика, материалы.
 Применение изделия не имеет противопоказаний и ограничений.
 Показатели и критерии оценки:
 Набор реагентов «Экспресс М-НВА1с-Турби» создан для определения содержания гемоглобина в крови человека, и

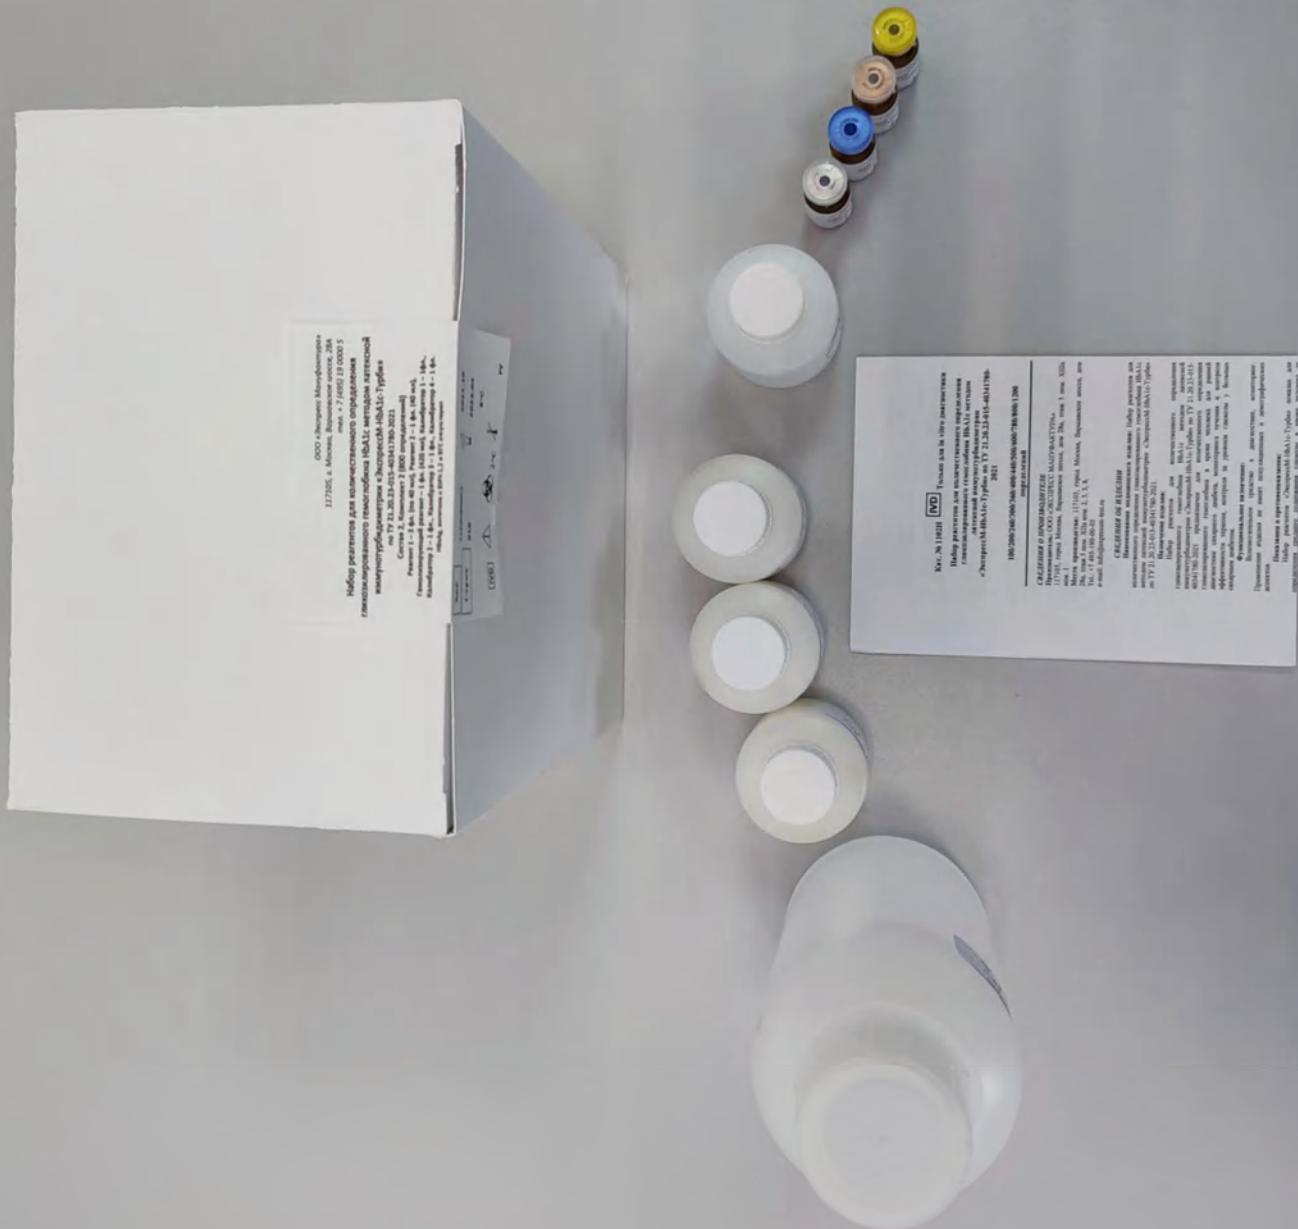

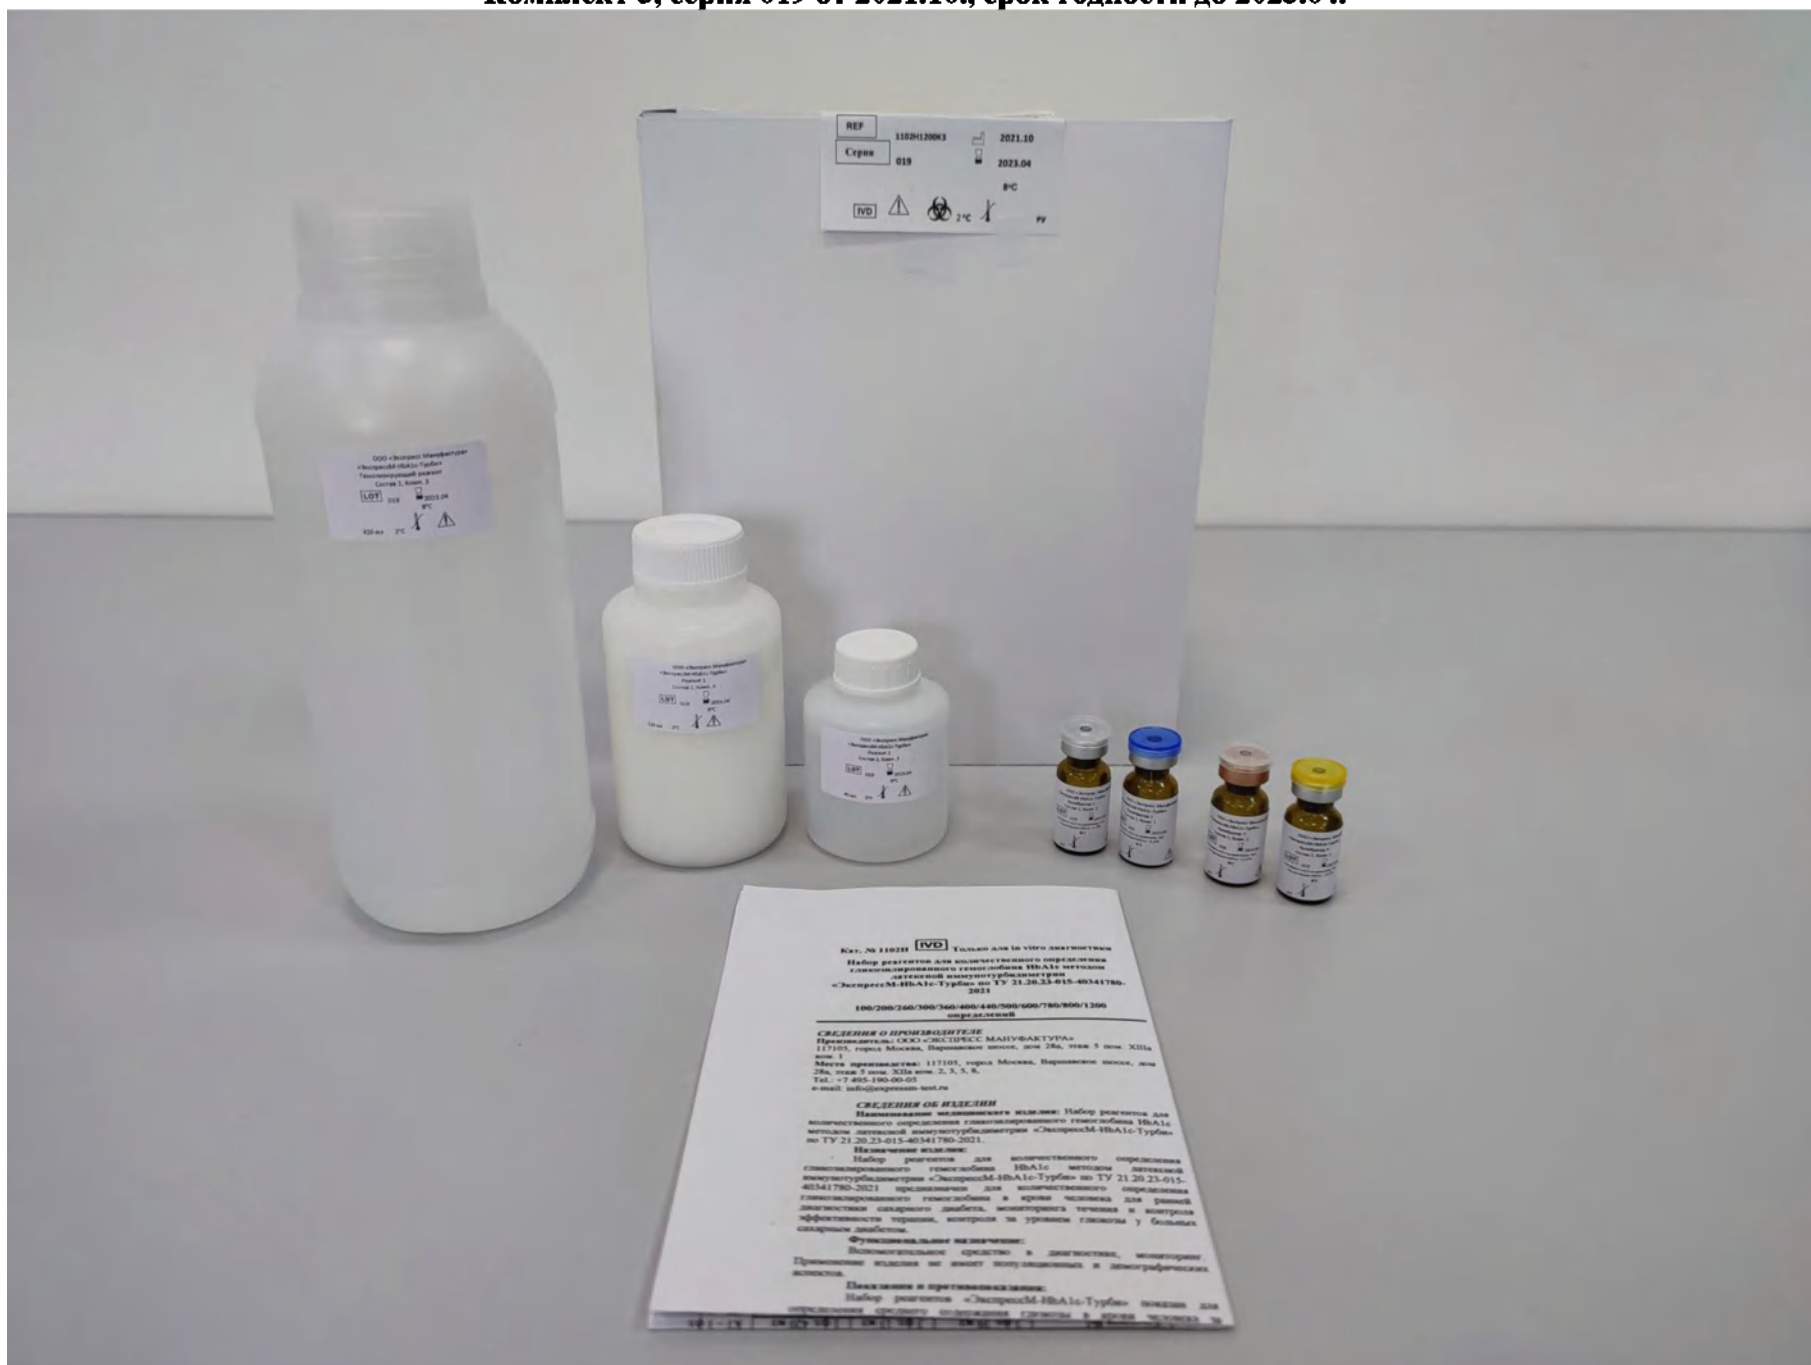

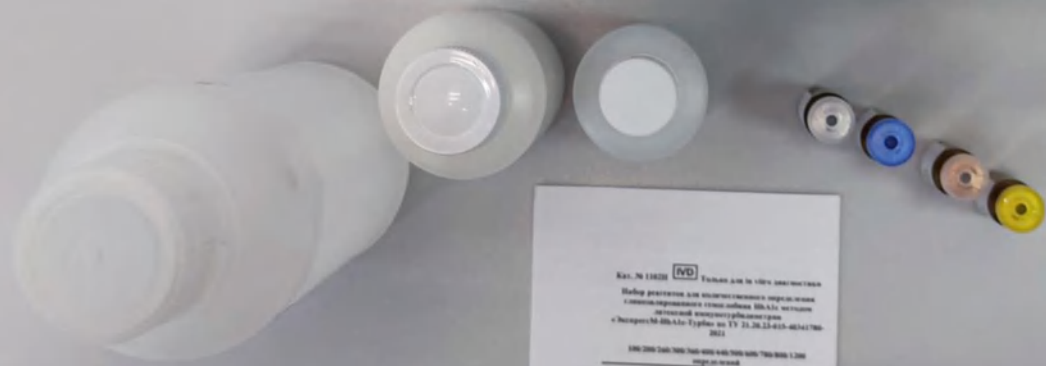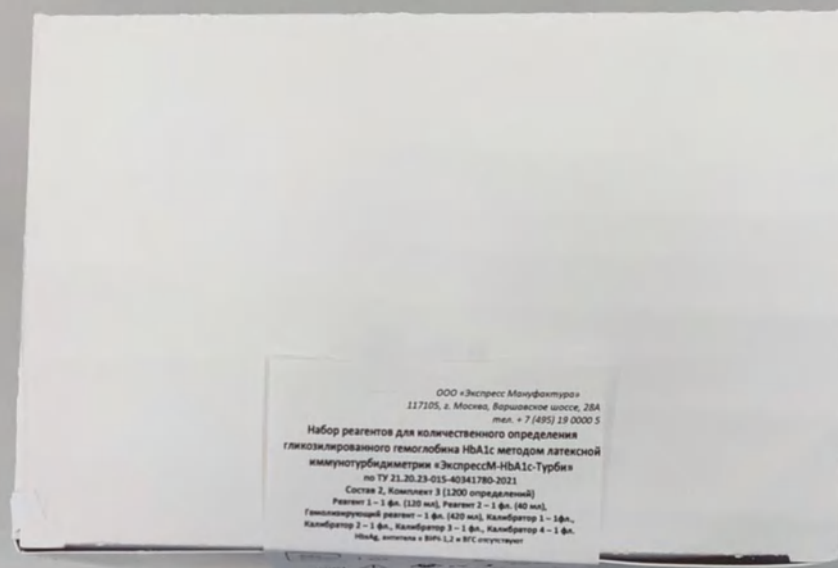

Кат. № 18020 **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-HbA1c-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021
 Состав: 2, Комплект 3 (1200 определений)
 Реагент 1 – 1 фла. (120 мл), Реагент 2 – 1 фла. (40 мл), Гемоглинирующий реагент – 1 фла. (420 мл), Калибратор 1 – 1 фла., Калибратор 2 – 1 фла., Калибратор 3 – 1 фла., Калибратор 4 – 1 фла. HbA1c, концентрация 0,04%, 0,2 и 0,5% отсутствуют


ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦИРМИ
 Варшавское шоссе, 28А, г. Москва, 117105
 Тел: +7 (495) 19 00 00 05
 E-mail: info@cirmi.ru
 Сайт: www.goszdravnadzor.ru


«Экспресс Мануфактура»
 Варшавское шоссе, 28А, г. Москва, 117105
 Тел: +7 (495) 19 00 00 05
 E-mail: info@exp-man.ru
 Сайт: www.exp-man.ru


«Экспресс Мануфактура»
 Варшавское шоссе, 28А, г. Москва, 117105
 Тел: +7 (495) 19 00 00 05
 E-mail: info@exp-man.ru
 Сайт: www.exp-man.ru


«Экспресс Мануфактура»
 Варшавское шоссе, 28А, г. Москва, 117105
 Тел: +7 (495) 19 00 00 05
 E-mail: info@exp-man.ru
 Сайт: www.exp-man.ru




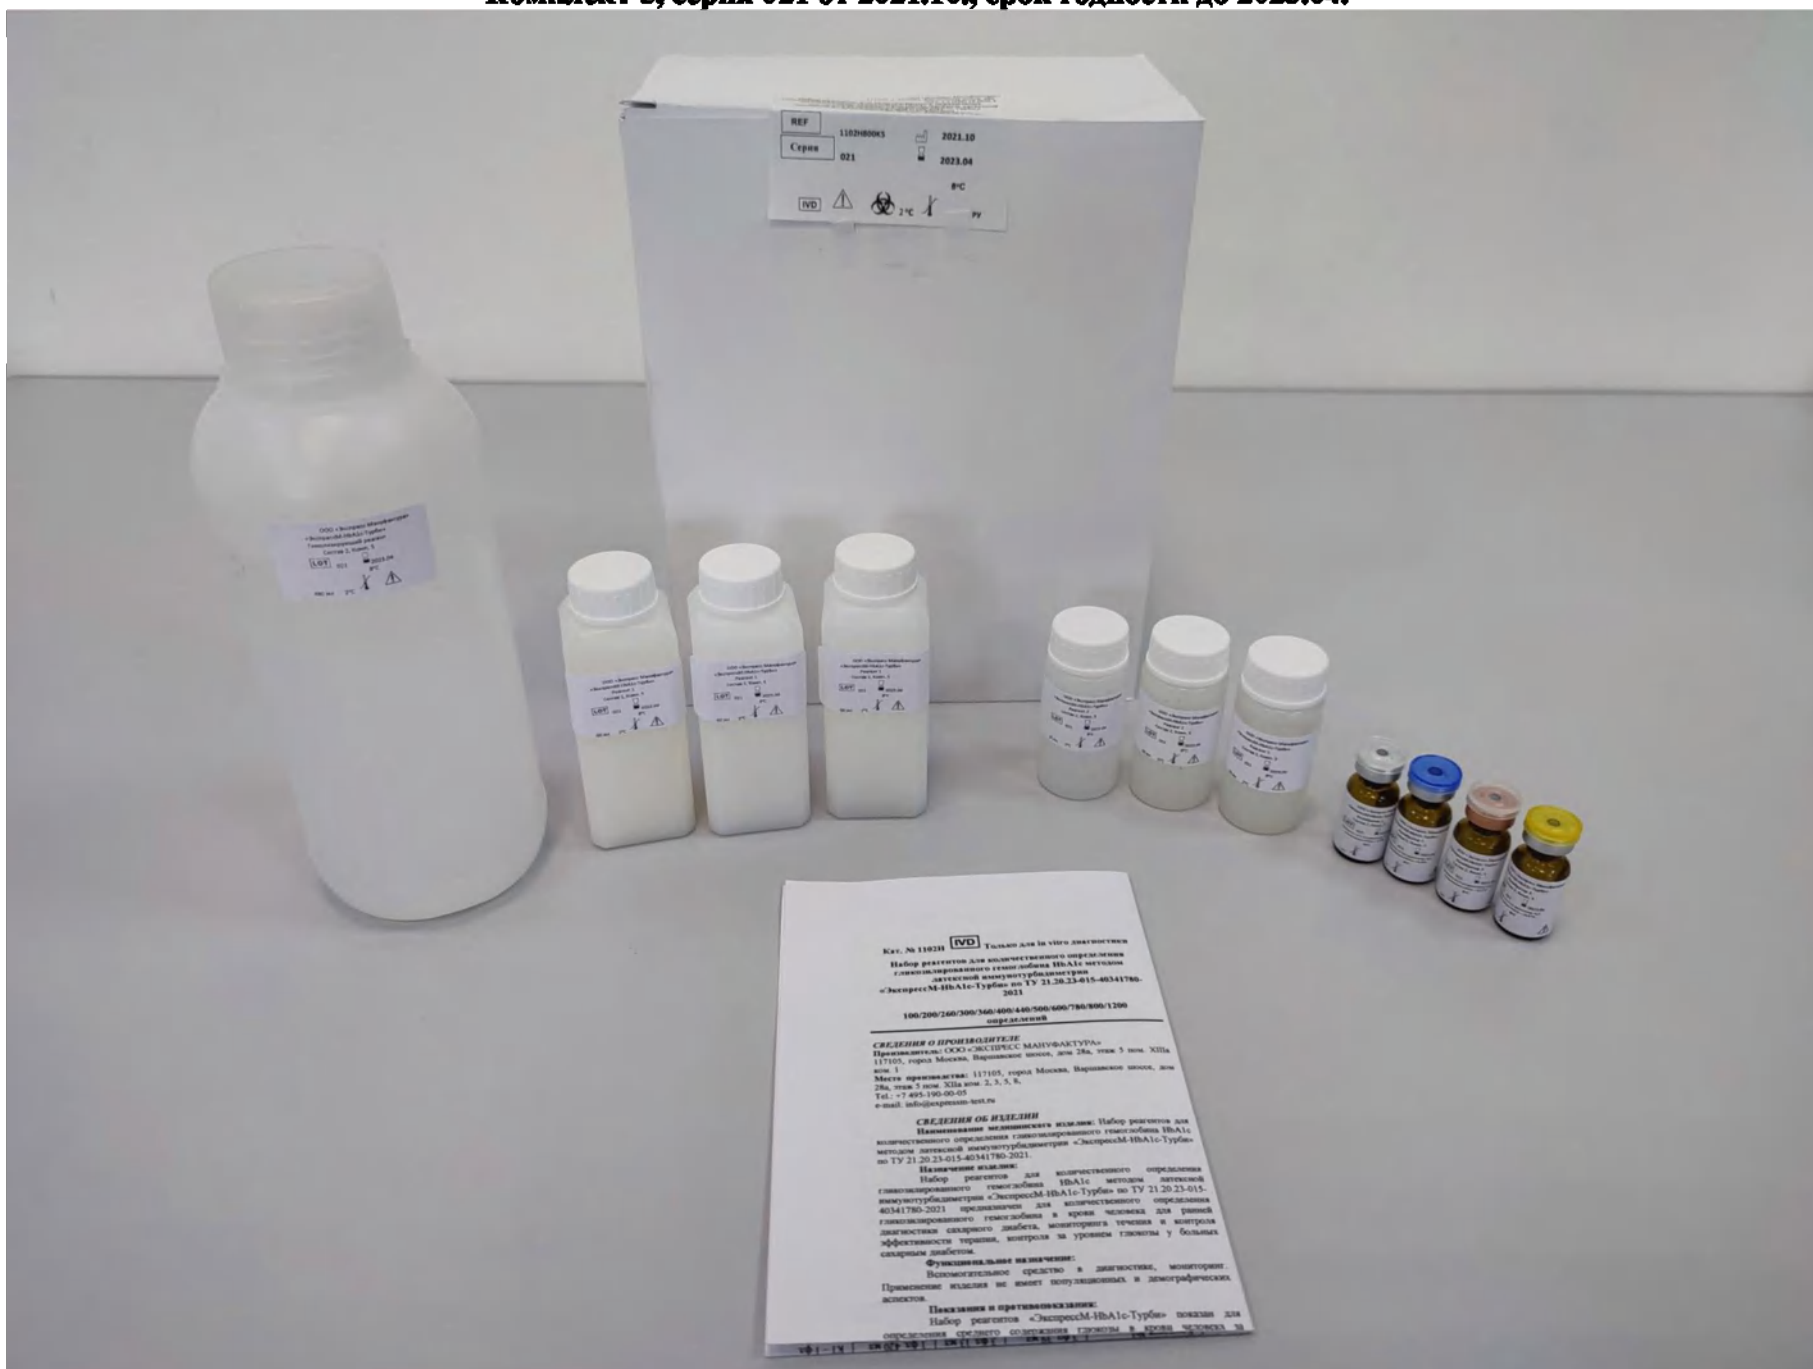

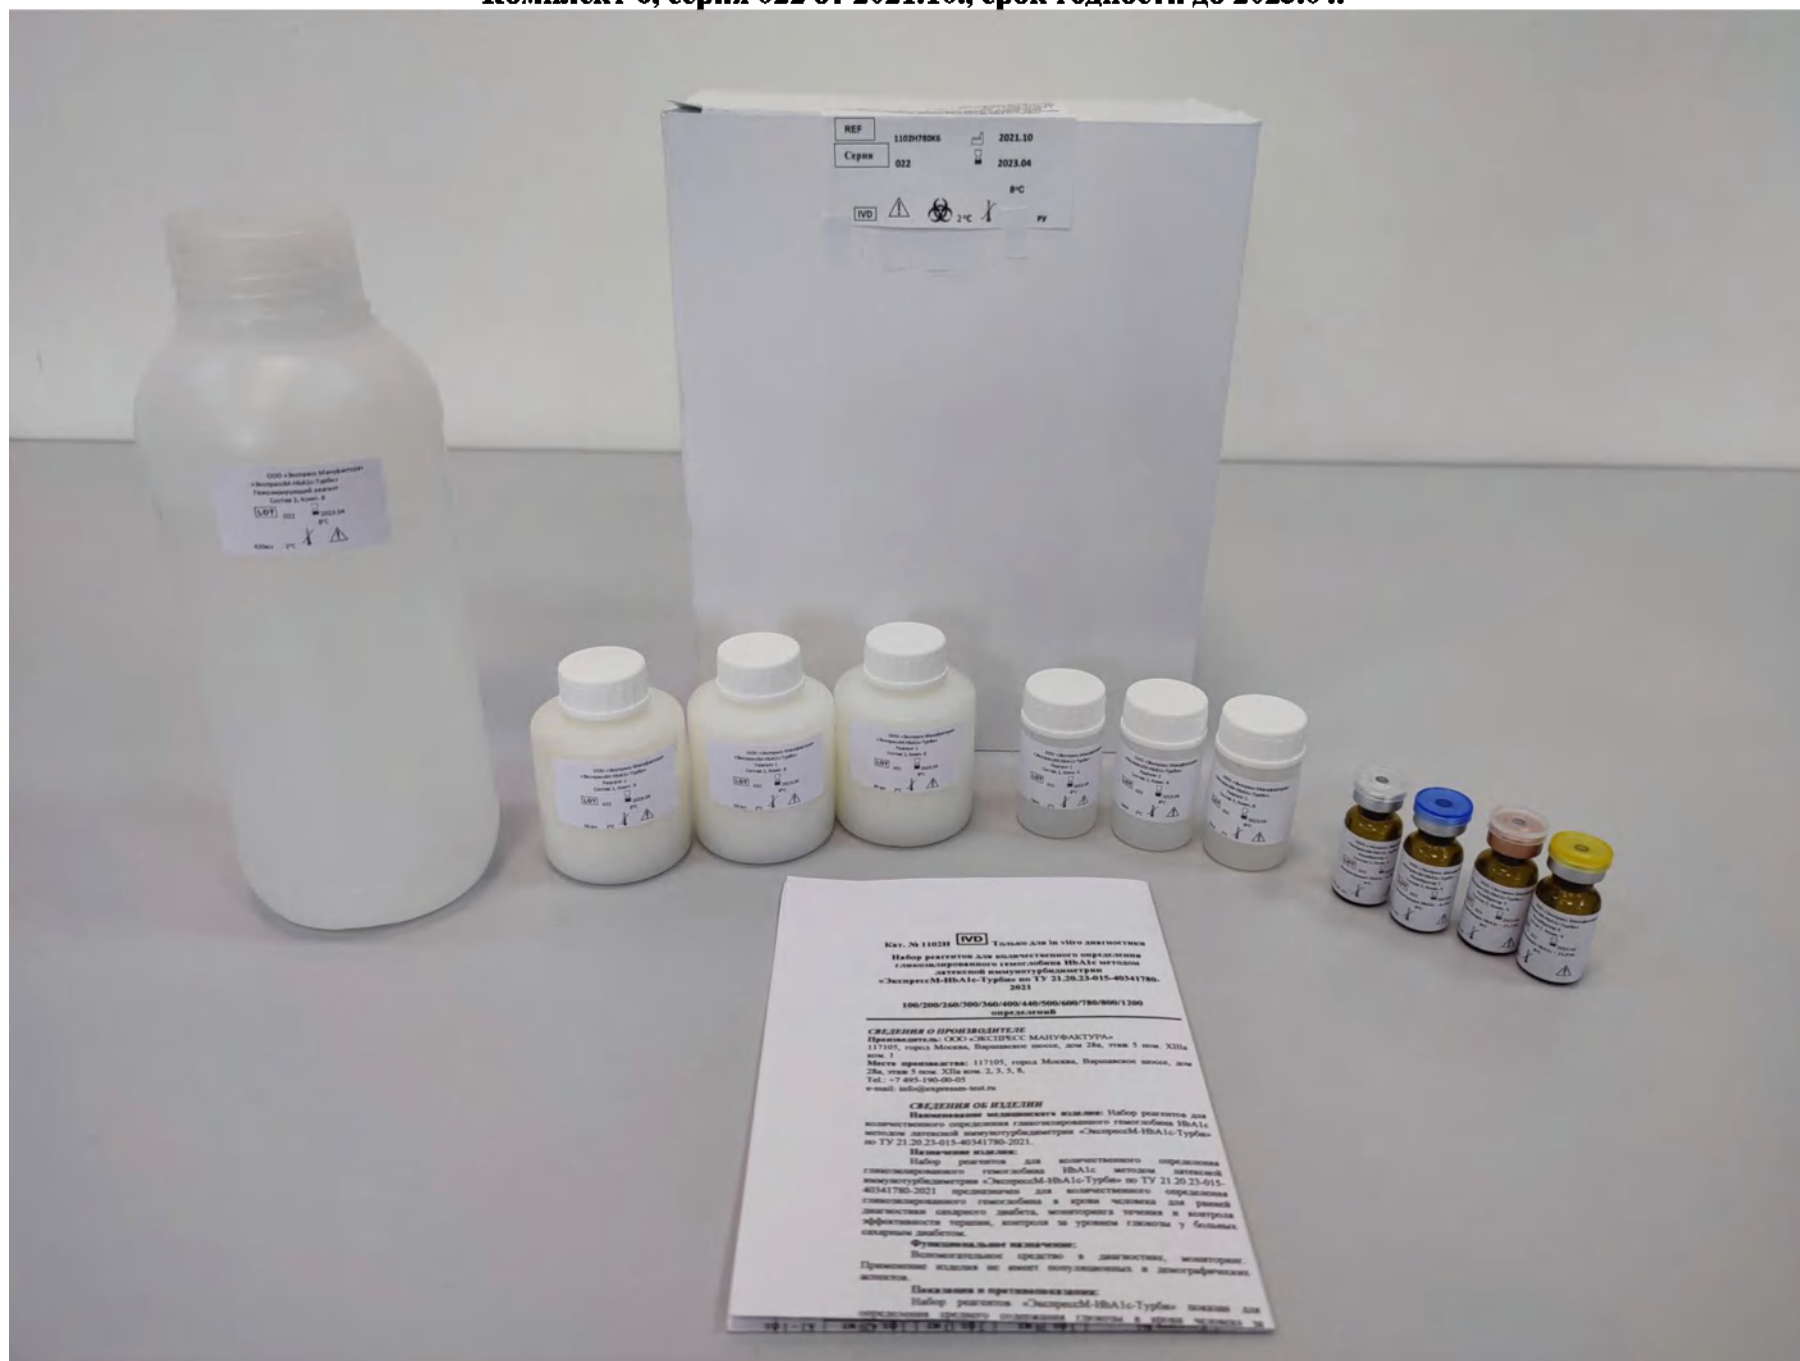

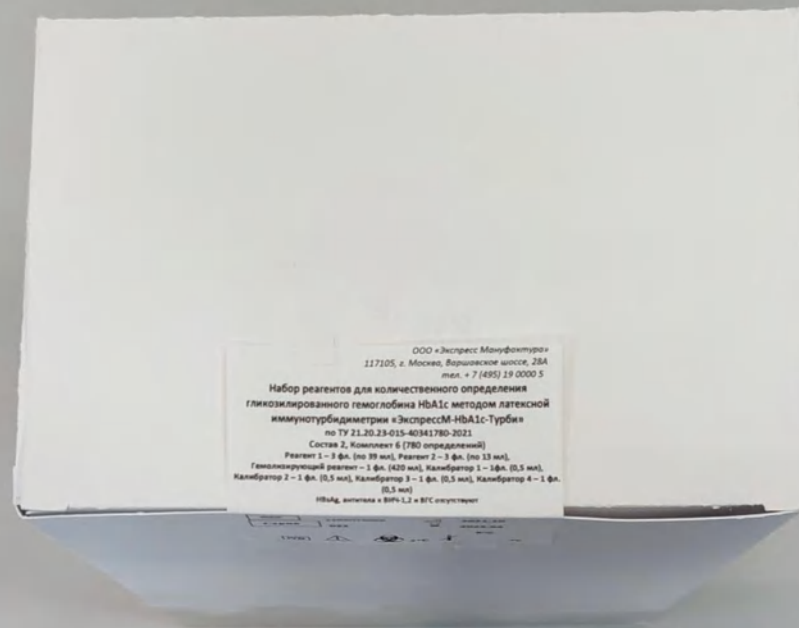

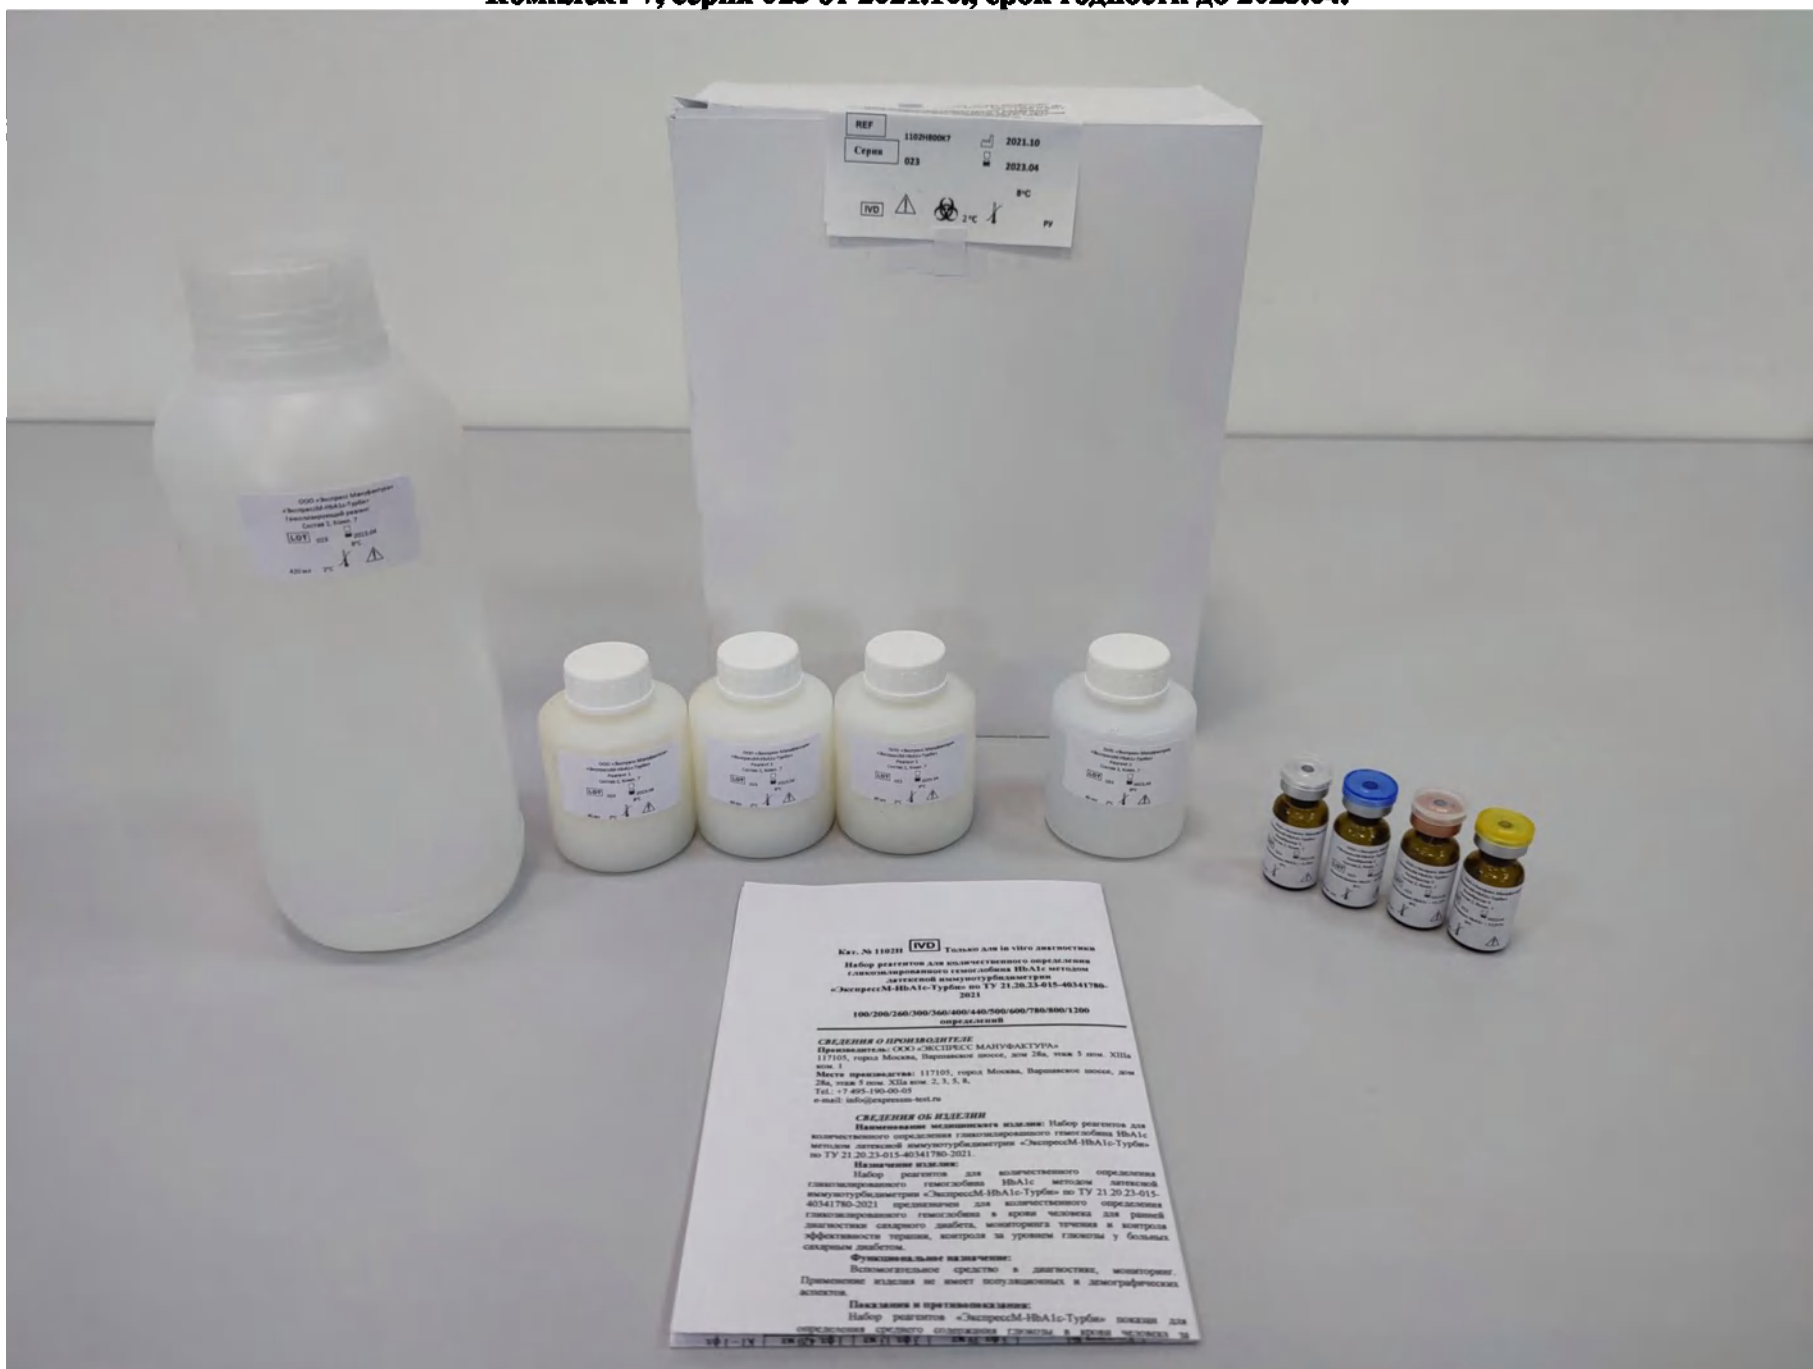


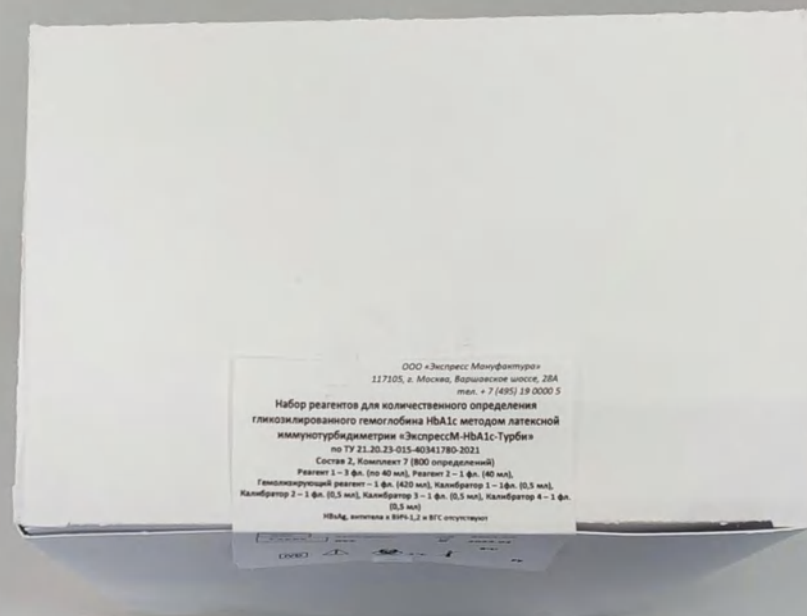

ООО «Экспресс-Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

**Набор реагентов для количественного определения
гликозилированного гемоглобина HbA1c методом латексной
иммунотурбидиметрии «Экспресс-HbA1c-Турби»**
по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021

Состав: 2, Компонент 7 (800 определений)
Реагент 1 – 3 фла. (по 40 мл), Реагент 2 – 1 фла. (40 мл),
Гемолизирующий реагент – 1 фла. (420 мл), Калибратор 1 – 1 фла. (0,5 мл),
Калибратор 2 – 1 фла. (0,5 мл), Калибратор 3 – 1 фла. (0,5 мл), Калибратор 4 – 1 фла.
(0,5 мл)
HbA_{1c} вилочки и Brix 1,2 и Brix 0,5 отсутствуют

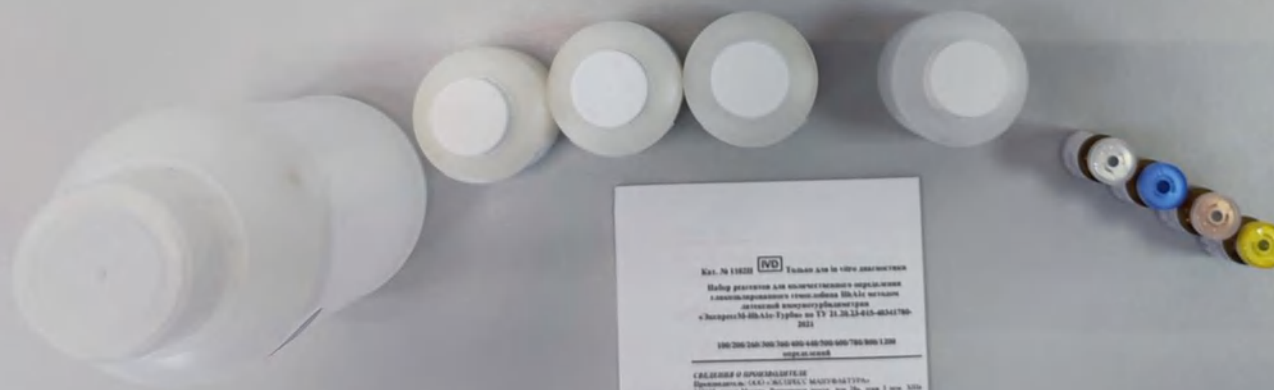


Кат. № 11820 **ИВД** Только для in vitro диагностики


**Набор реагентов для количественного определения
гликозилированного гемоглобина HbA_{1c} методом
латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-HbA_{1c}-Турби» по ТУ 21.20.23-015-40341780-
2021**


1800 7000 7000 7000 600 400 400 7000 600 7000 600 1 000
опред. на анализ


СВЕТЛОСЕРВ И ПРОДВИНУТЫЕ РЕШЕНИЯ
Промышленность (СНП) - ООО СВЕТЛОСЕРВ И ПРОДВИНУТЫЕ РЕШЕНИЯ
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3 или 3А/3Б
или 1
Москва, промышленная: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом
28А, этаж 3 или 3А/3Б или 3.1.1.1.1.
Тел.: +7 (495) 190-00-05
e-mail: info@svetloserve.ru




СВЕТЛОСЕРВ ИВ И В-150-1000
Вспомогательные материалы: Набор реагентов для
количественного определения гликозилированного гемоглобина HbA_{1c}
методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-HbA_{1c}-Турби»
по ТУ 21.20.23-015-40341780-2021.
Материалы в комплекте:
Набор реагентов для количественного определения
гликозилированного гемоглобина HbA_{1c} методом латексной
иммунотурбидиметрии «Экспресс-HbA_{1c}-Турби» по ТУ 21.20.23-015-
40341780-2021 предназначен для количественного определения
гликозилированного гемоглобина в жидких пробах для рутинной
диагностики сахарного диабета лабораторными методами в формате
эффективной работы, скорости и качества анализа 1 флакон
содержит 400 порций.
Функциональные назначения:
Вспомогательные материалы и материалы, необходимые
для проведения анализа на анализаторах и лабораторных
методах.
Целевая аудитория:
Набор реагентов «Экспресс-HbA_{1c}-Турби» можно использовать
для количественного определения гликозилированного гемоглобина в жидких пробах.

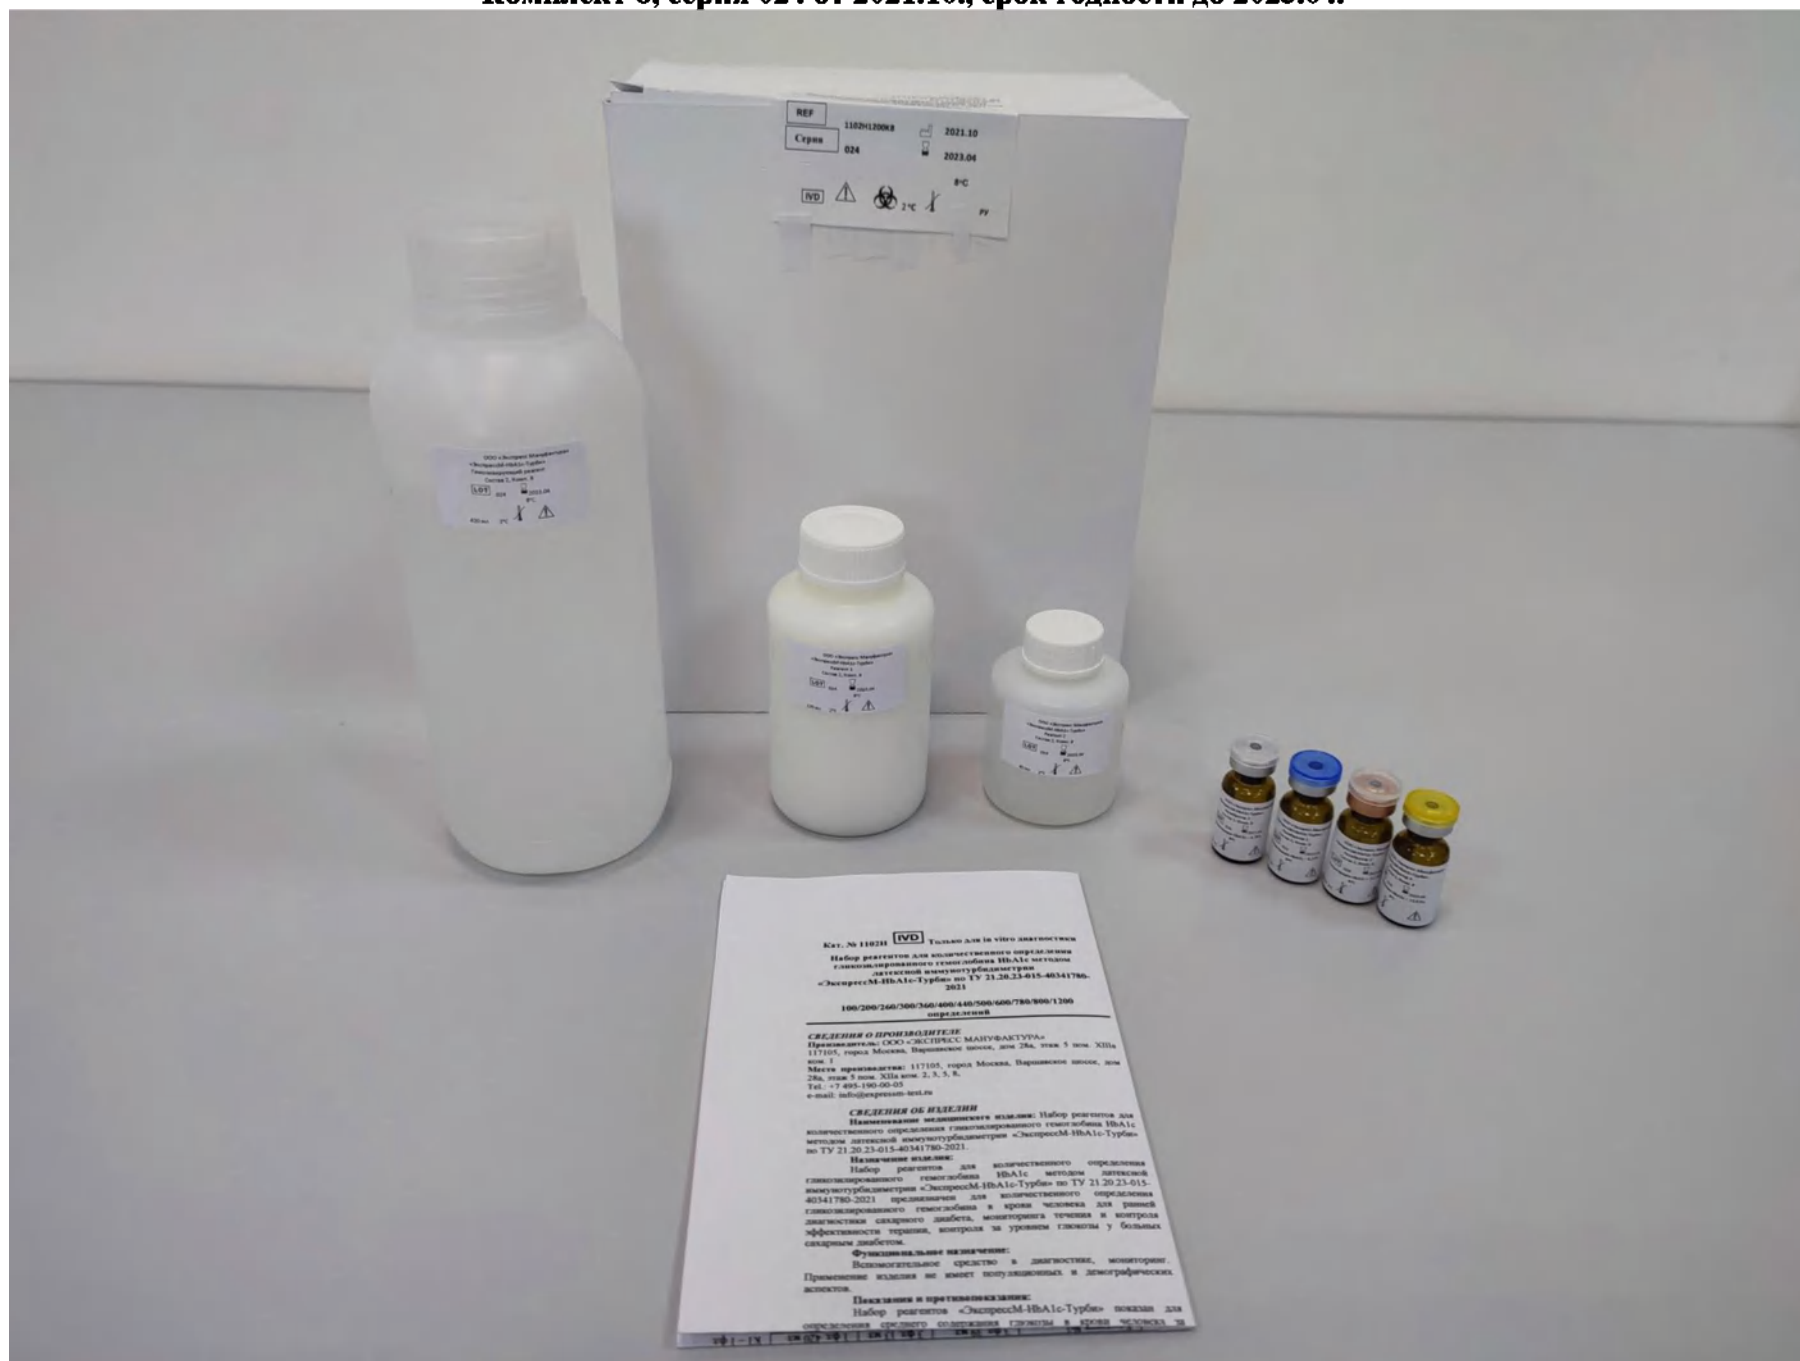

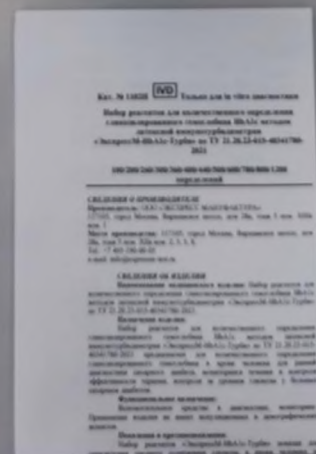

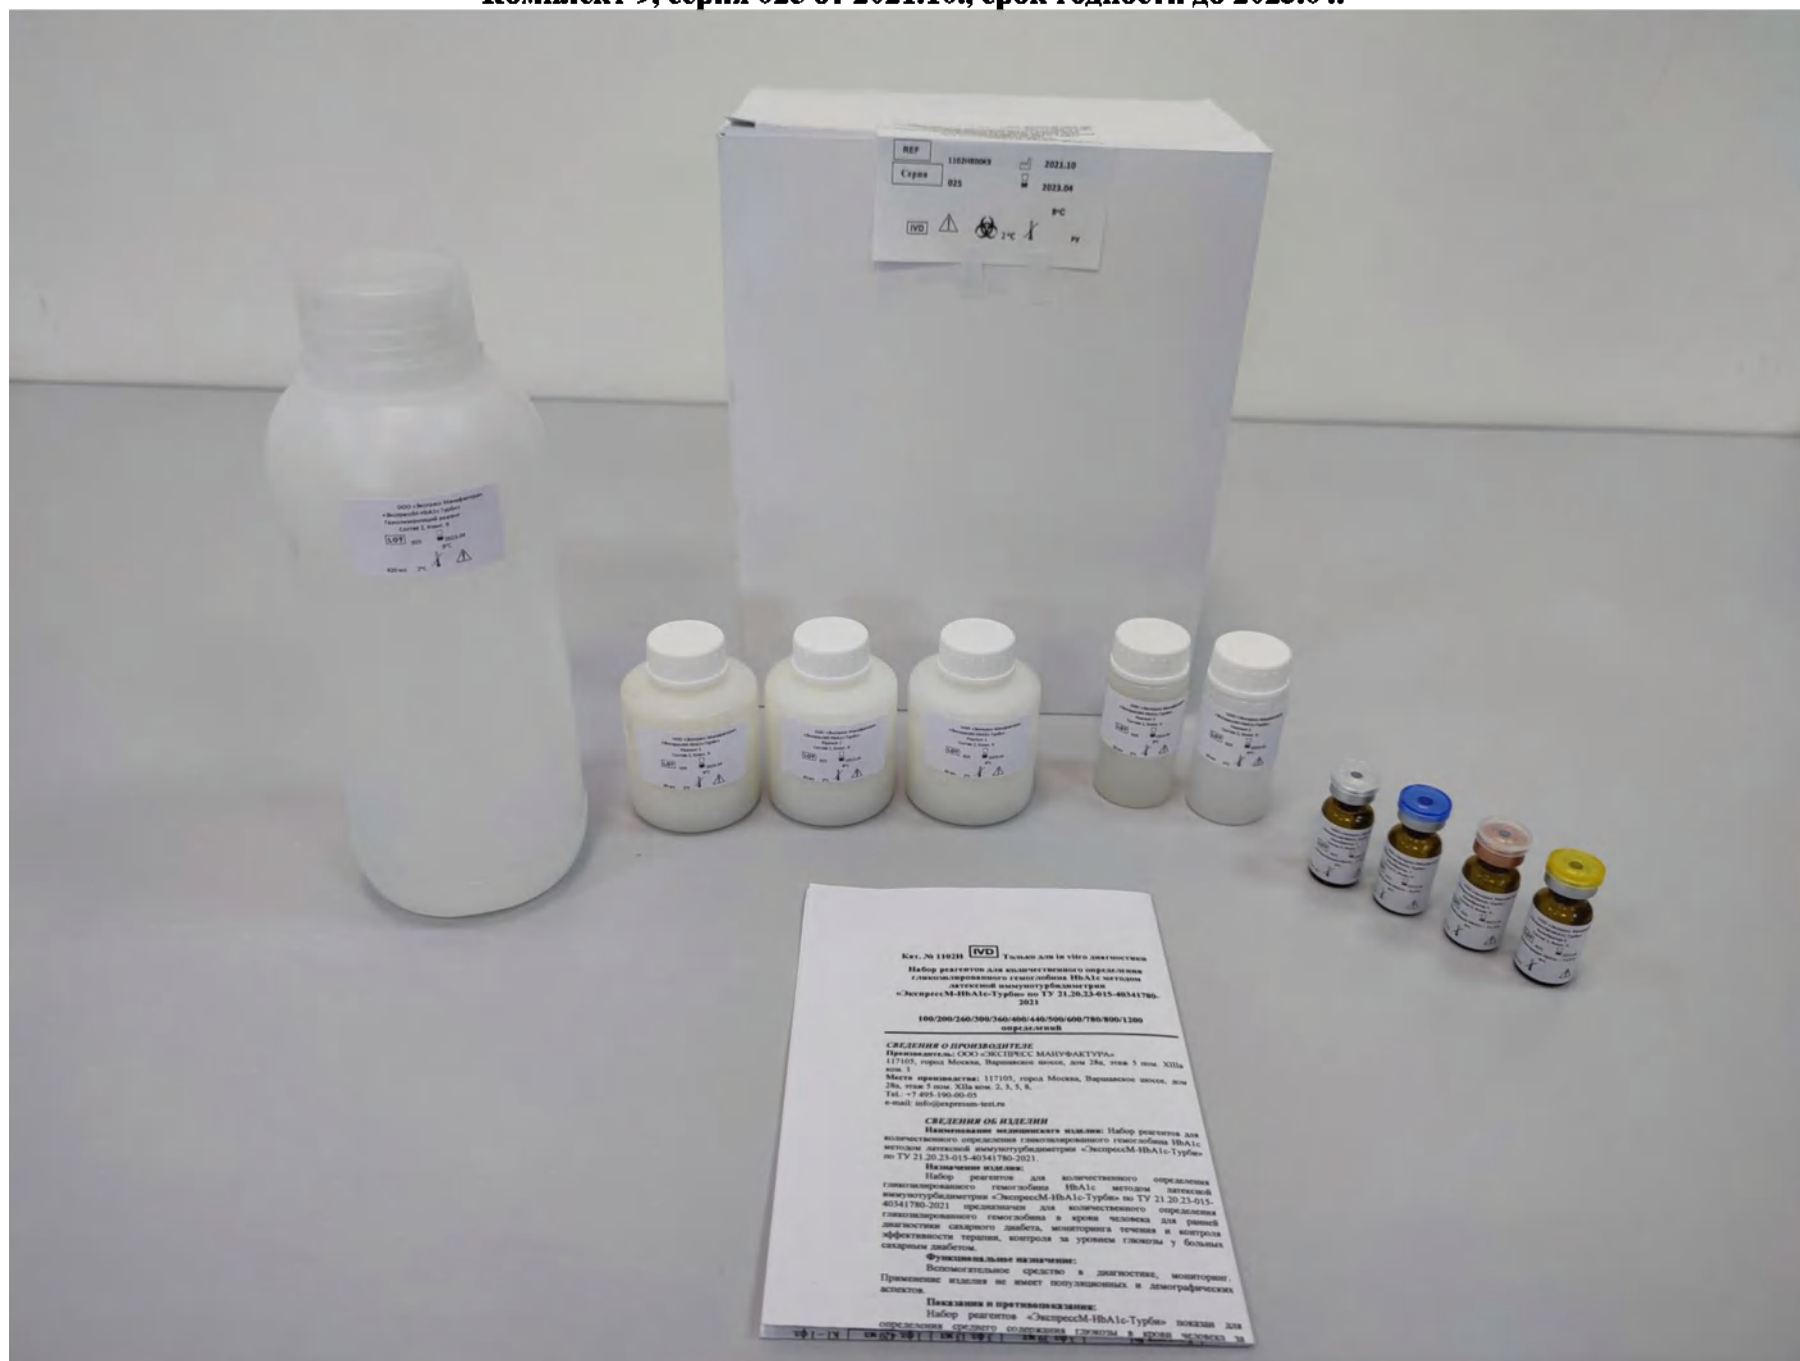

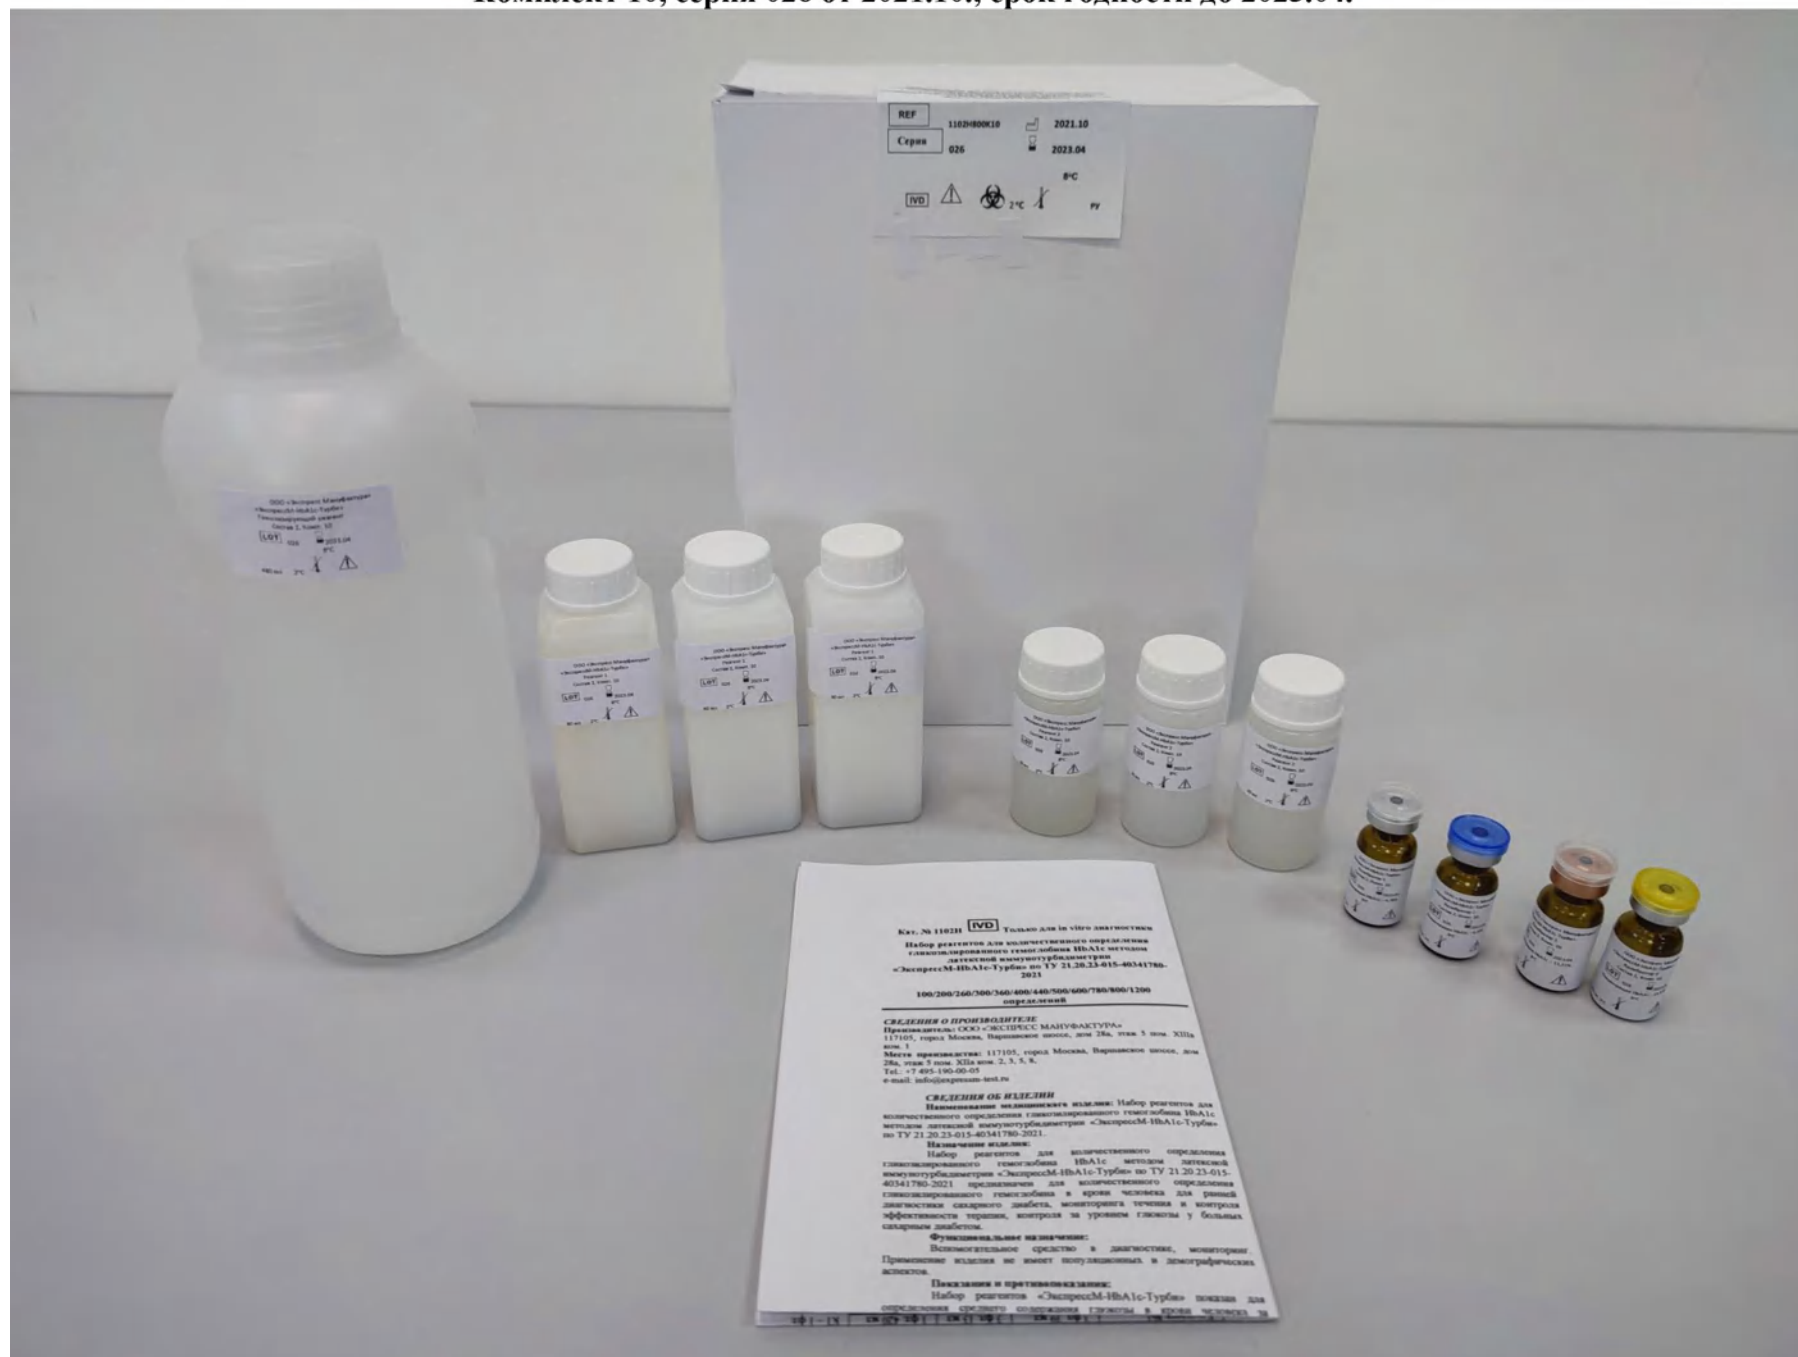


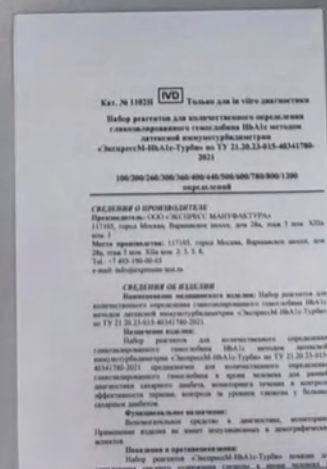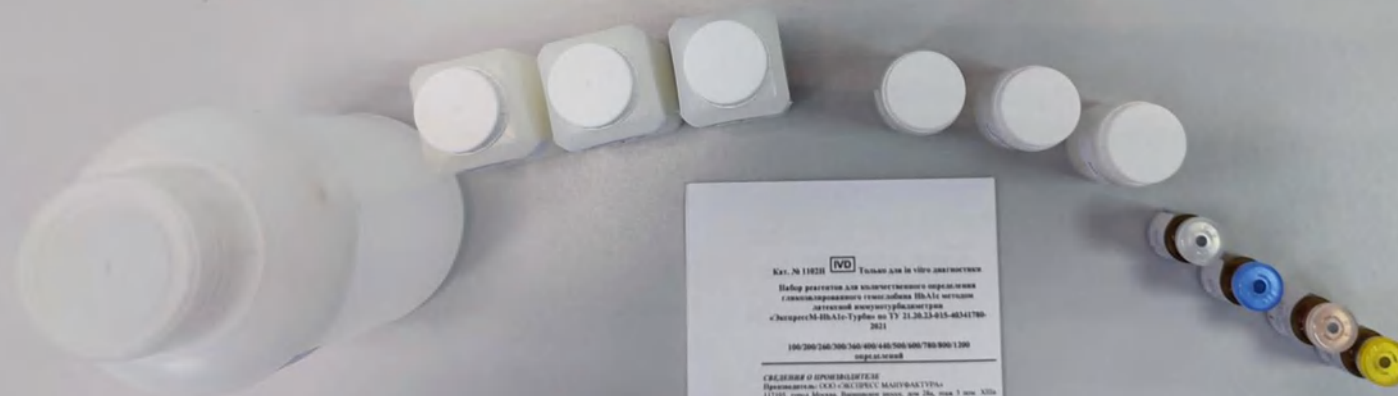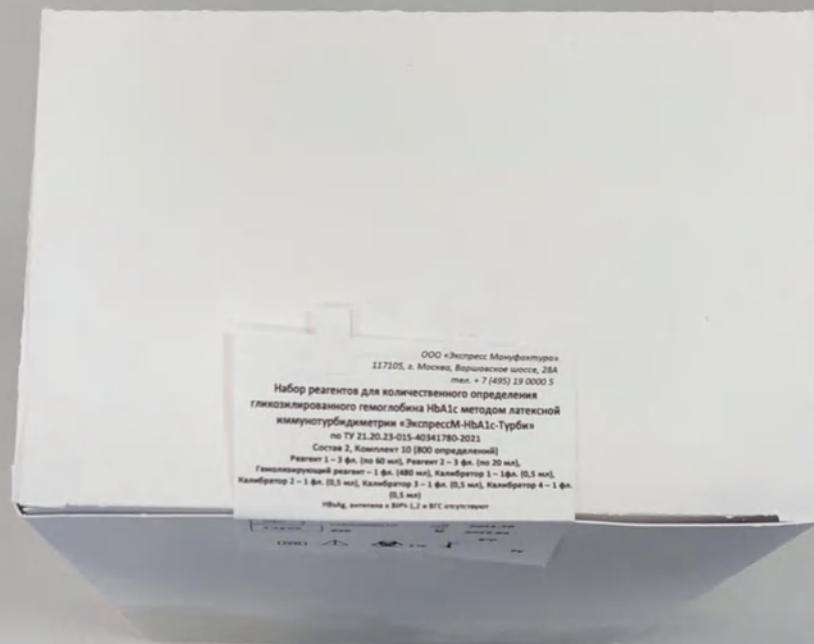


1. Реагент 1



2. Реагент 2

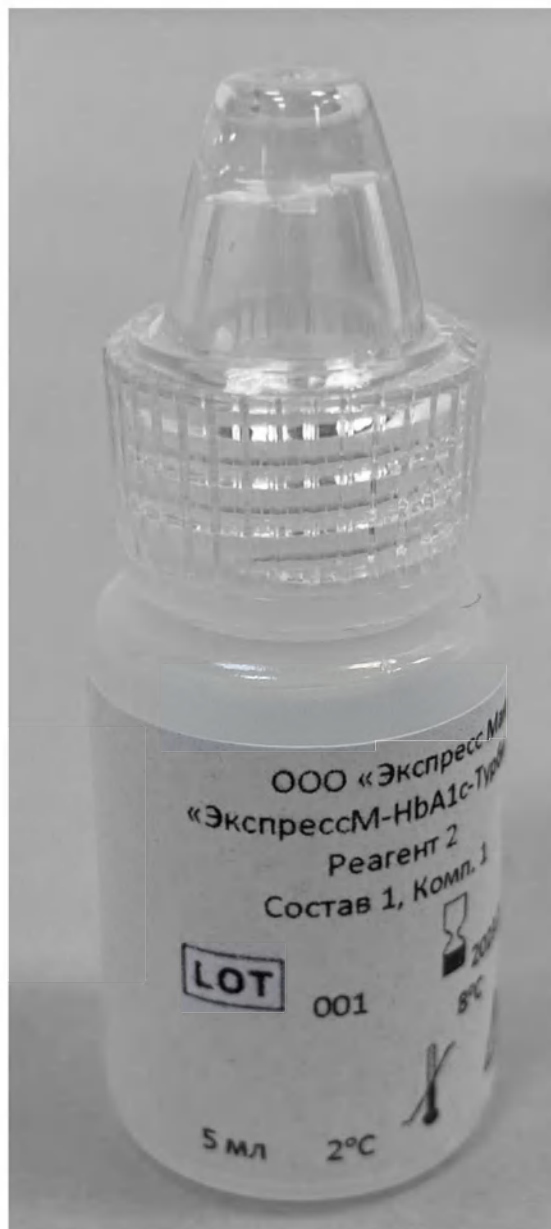

3. Гемолизирующий реагент

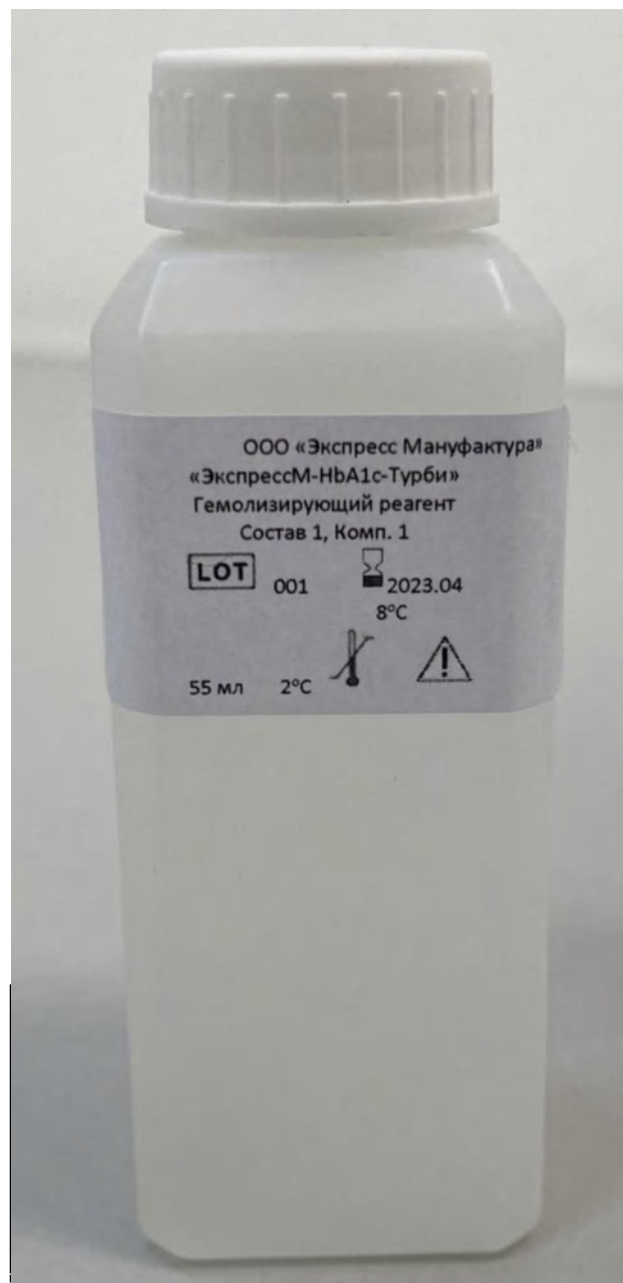


4. Калибраторы



5. Упаковка



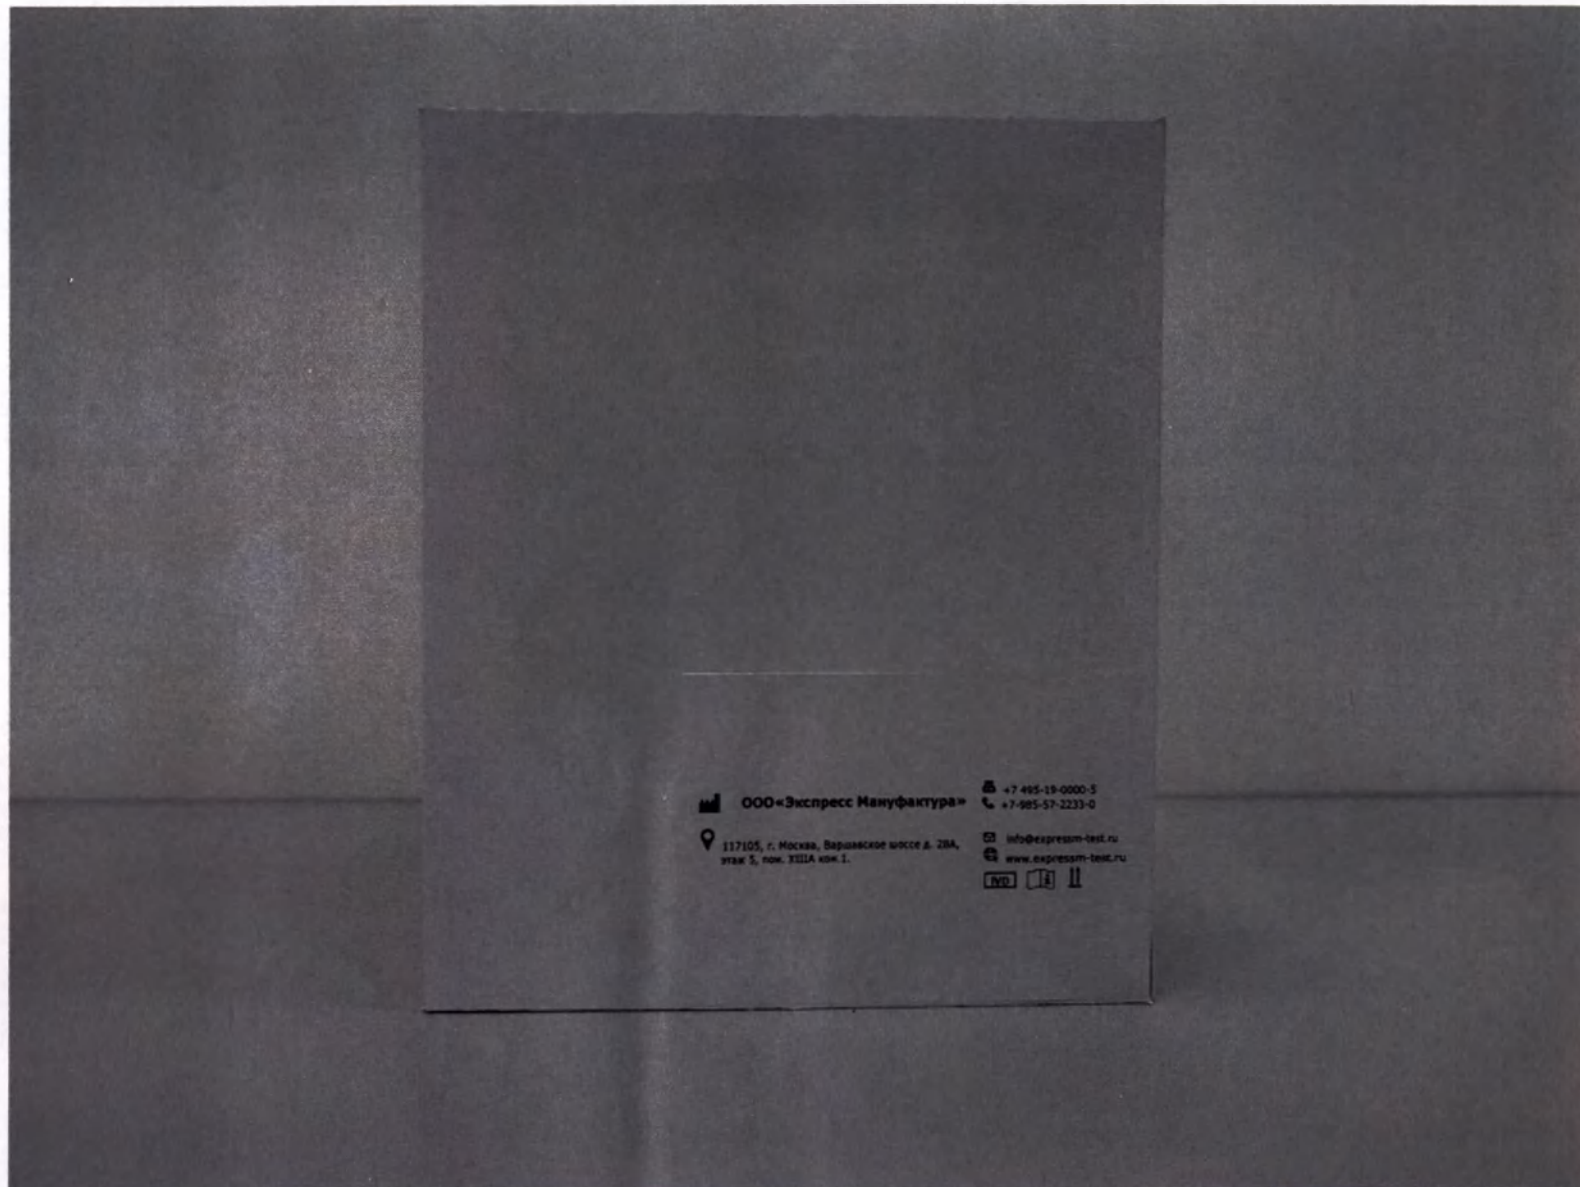

 **ООО «Экспресс Мануфактура»**  +7 495-19-0000-5
 +7 905-57-2233-0
 117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 28А,
этаж 5, пом. ХХША ком. 1.  info@expressm-test.ru
 www.expressm-test.ru
  

Генеральный директор ООО «Экспресс Мануфактура»



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

58 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И.В.

« 20 » 09 20 22 г.

