



117105, ГОРОД МОСКВА,
Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 28А, ЭТАЖ 5 ПОМ. ХIIIA КОМ.1
Факт. адрес: 117105, ГОРОД МОСКВА,
Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 28А, ЭТАЖ 5 ПОМ. ХIIА КОМ.2, 3, 5, 8

+7 (495) 190-00-05
+7 (985) 572-23-30
info@expressm-test.ru
expressm-test.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Мануфактура»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»
Кириев И.В.
« 3 » сентября 2022 г.



ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым
ферментативно-фотометрическим методом
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по
ТУ№ 21.20.23-017-40341780-2021
Состав 1, Комплект 13 (300 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (90 мл), Реагент 2 – 1 фл. (30 мл)

REF	3020C300.13	2021.09
Серия	013	2023.09

8°C



2°C



РУ

ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым
ферментативно-фотометрическим методом
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по
ТУ№ 21.20.23-017-40341780-2021
Состав 2, Комплект 7 (200 определений)
Реагент 1 – 3 фл. (по 20 мл), Реагент 2 – 1 фл. (20 мл), калибратор – 1 фл.
HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и к ВГС отсутствуют

REF	3020C200K7.2	2021.09
Серия	026	2023.09

8°C



2°C



РУ

ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения
холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке
крови прямым ферментативно-фотометрическим методом

«ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по

ТУ № 21.20.23-017-40341780-2021

Состав 3, Комплект 3 (130 определений)

Реагент 1 – 1 фл. (39 мл), Реагент 2 – 1 фл. (13 мл),
калибратор – 1 фл. (0,5 мл).

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и к ВГС отсутствуют

REF	3020C130K3.3.		2021.09
Серия	041		2023.09

8°C

IVD



2°C



РУ

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Реагент 1

Состав 1, Комп. 2

LOT

002



2023.09

8°C

10 мл

2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Реагент 1

Состав 2, Комп. 3

LOT

022



2023.09

8°C

39 мл

2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Реагент 1

Состав 3, Комп. 8

LOT

046



2023.09

8°C

20 мл

2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Реагент 2

Состав 1, Комп. 3

LOT

003



2023.09

8°C

13 мл

2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Реагент 2

Состав 2, Комп. 3

LOT

022



2023.09

8°C

13 мл

2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Реагент 2

Состав 3, Комп. 5

LOT

043



2023.09

8°C

18 мл

2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Калибратор

Состав 2, Комп. 3

LOT

022



2023.03

Растворить в 1 мл деионизир. H₂O

Концентрация холестерина HDL-1,65 ммоль/л

8°C

2°C



ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Калибратор

Состав 3, Комп. 3

LOT

041



2023.03

Концентрация холестерина HDL-1,65 ммоль/л

8°C

0,5 мл

2°C



Наименование предприятия-изготовителя, контакты, знаки «только для in vitro диагностики» и «обратитесь к инструкции по применению» указаны на этикетке:



ООО «Экспресс Мануфактура»



+7 495-19-0000-5
+7-985-57-2233-0



117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 28А,
этаж 5, пом. XIIIА кон.1.



info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru



Начальник производства

Начальник отдела контроля качества



А.А. Ивчин

М.А. Лесняк

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью



3 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»


Киреев И.В.



« 20 » 09 2022



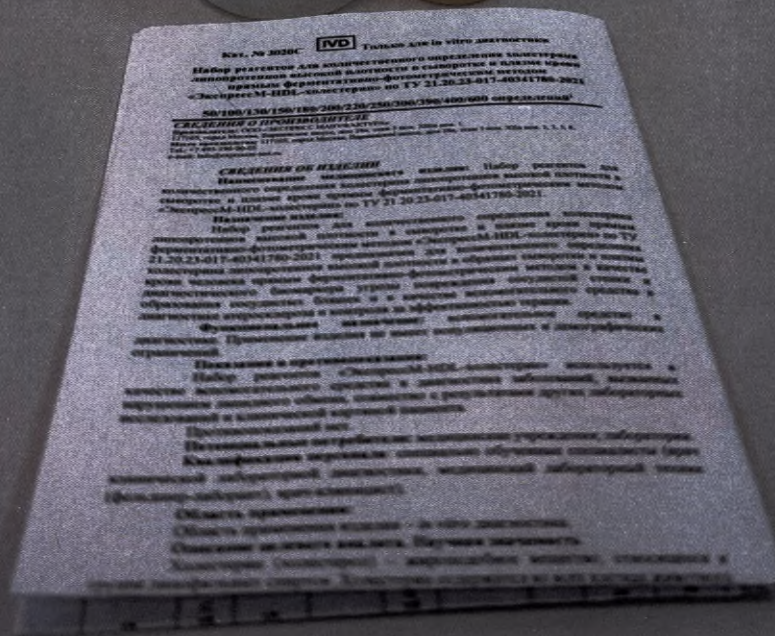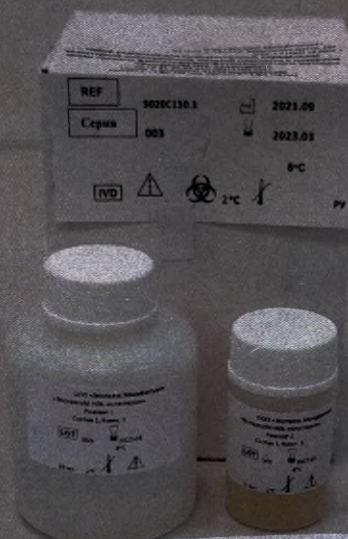

**Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом
«Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021**
Состав 1 Комплект 1, серия 001 от 2021.09., срок годности до 2023.03.

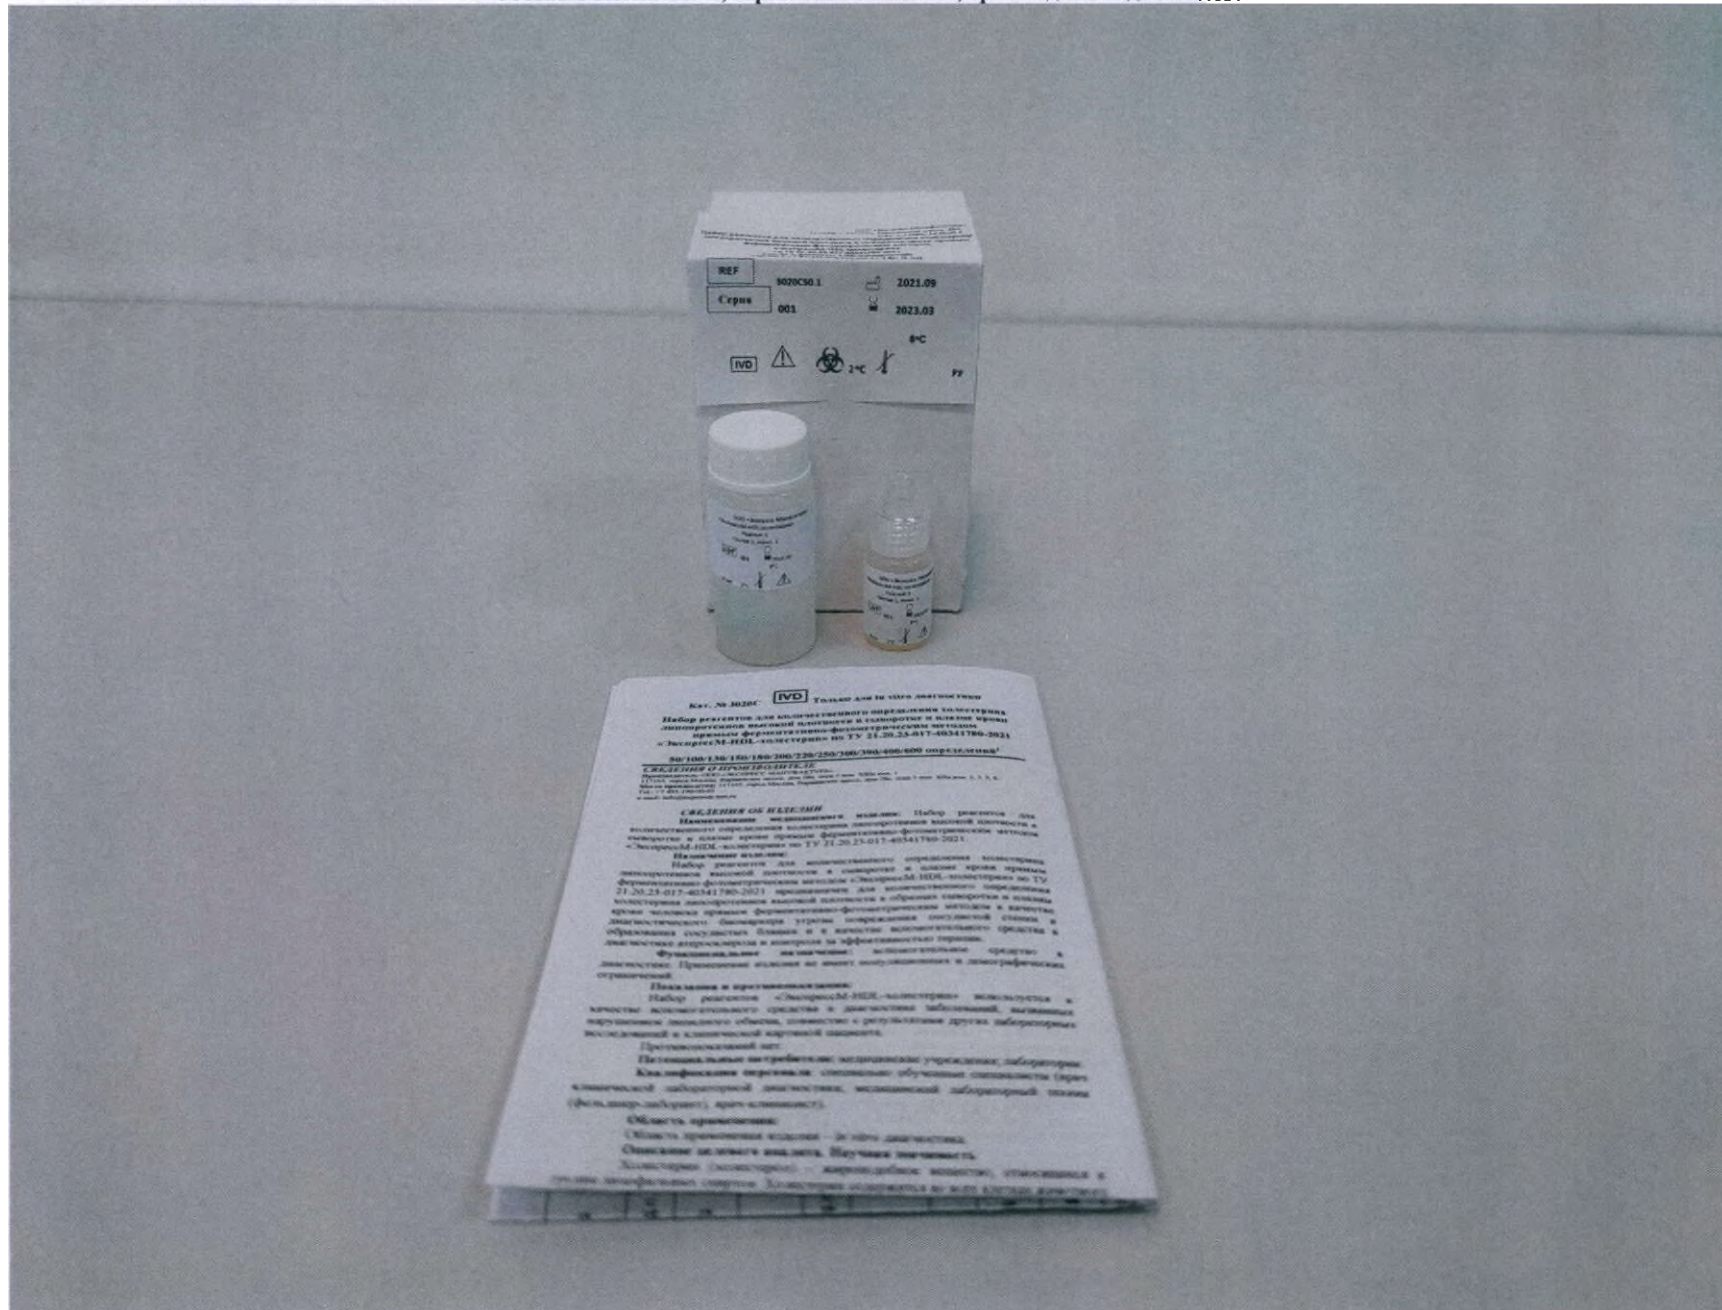

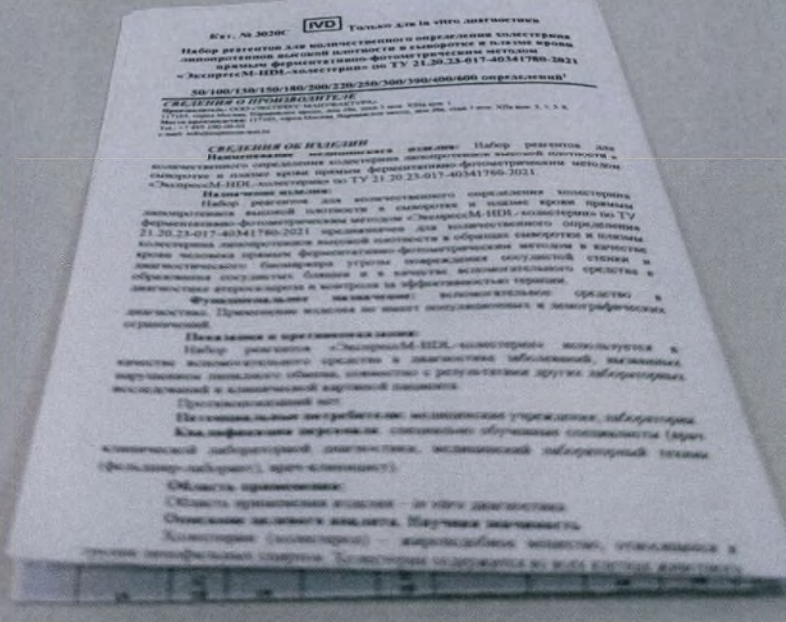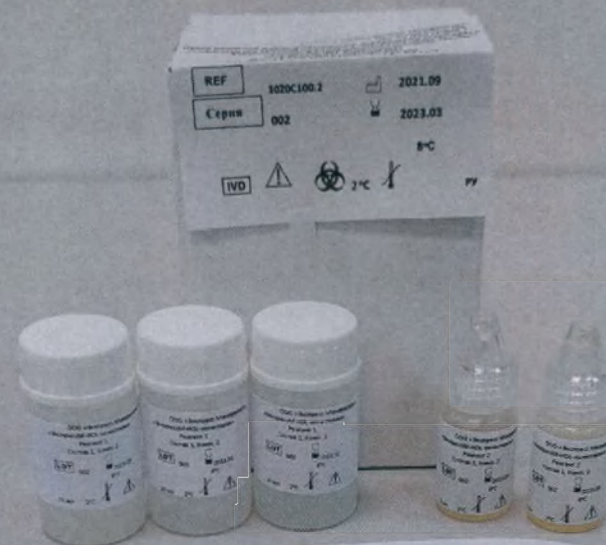

ООО «Экспресс-Мониторинг»
127105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А
тел.: 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения
холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке
крови методом ферментативно-фотометрическим методом

«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

Состав 1, Комплект 4 (150 определений)

Реактив 1 – 1 фла. (45 мл), Реактив 2 – 1 фла. (15 мл)

Кат. № 3026C **VD** Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина
липидов в сыворотке крови методом ферментативно-фотометрическим методом
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

500 100 150 150 180 200 250 300 350 400 450 500 определений

«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Состав 1, Комплект 4 (150 определений)

Реактив 1 – 1 фла. (45 мл), Реактив 2 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 3 – 1 фла. (15 мл), Реактив 4 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 5 – 1 фла. (15 мл), Реактив 6 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 7 – 1 фла. (15 мл), Реактив 8 – 1 фла. (15 мл)

Состав 1, Комплект 4 (150 определений)

Набор реагентов для количественного определения холестерина
липидов в сыворотке крови методом ферментативно-фотометрическим методом
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

500 100 150 150 180 200 250 300 350 400 450 500 определений

«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»

Состав 1, Комплект 4 (150 определений)

Реактив 1 – 1 фла. (45 мл), Реактив 2 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 3 – 1 фла. (15 мл), Реактив 4 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 5 – 1 фла. (15 мл), Реактив 6 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 7 – 1 фла. (15 мл), Реактив 8 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 9 – 1 фла. (15 мл), Реактив 10 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 11 – 1 фла. (15 мл), Реактив 12 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 13 – 1 фла. (15 мл), Реактив 14 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 15 – 1 фла. (15 мл), Реактив 16 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 17 – 1 фла. (15 мл), Реактив 18 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 19 – 1 фла. (15 мл), Реактив 20 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 21 – 1 фла. (15 мл), Реактив 22 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 23 – 1 фла. (15 мл), Реактив 24 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 25 – 1 фла. (15 мл), Реактив 26 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 27 – 1 фла. (15 мл), Реактив 28 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 29 – 1 фла. (15 мл), Реактив 30 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 31 – 1 фла. (15 мл), Реактив 32 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 33 – 1 фла. (15 мл), Реактив 34 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 35 – 1 фла. (15 мл), Реактив 36 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 37 – 1 фла. (15 мл), Реактив 38 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 39 – 1 фла. (15 мл), Реактив 40 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 41 – 1 фла. (15 мл), Реактив 42 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 43 – 1 фла. (15 мл), Реактив 44 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 45 – 1 фла. (15 мл), Реактив 46 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 47 – 1 фла. (15 мл), Реактив 48 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 49 – 1 фла. (15 мл), Реактив 50 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 51 – 1 фла. (15 мл), Реактив 52 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 53 – 1 фла. (15 мл), Реактив 54 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 55 – 1 фла. (15 мл), Реактив 56 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 57 – 1 фла. (15 мл), Реактив 58 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 59 – 1 фла. (15 мл), Реактив 60 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 61 – 1 фла. (15 мл), Реактив 62 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 63 – 1 фла. (15 мл), Реактив 64 – 1 фла. (15 мл)



Реактив 65 – 1 фла. (15 мл), Реактив 66 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 67 – 1 фла. (15 мл), Реактив 68 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 69 – 1 фла. (15 мл), Реактив 70 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 71 – 1 фла. (15 мл), Реактив 72 – 1 фла. (15 мл)

Реактив 73 – 1 фла. (15 мл), Реактив 74 – 1 фла. (15 мл)

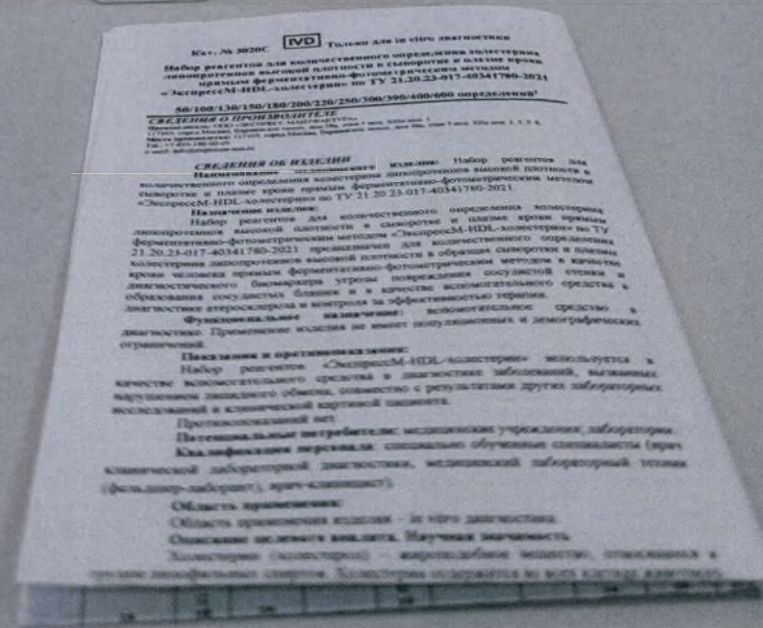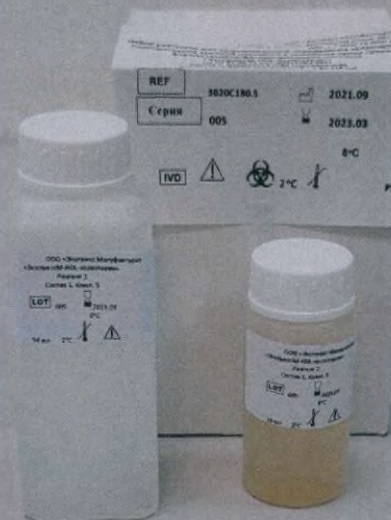

ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым
ферментативно-фотометрическим методом
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»
по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021
Состав 1, Комплект 5 [180 определений]
Реагент 1 – 1 фл. [54 мл], Реагент 2 – 1 фл. [18 мл]



Кат. № 2020C **IVD** Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови
прямым ферментативно-фотометрическим методом
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

50/100/150/180/200/220/250/300/390/400/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Владельцы: ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, стр. 1
Место производства: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, стр. 1
Тел.: +7 (495) 1900005
e-mail: info@expm.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Назначение медицинского изделия: Набор реагентов для
количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в
сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.

Назначение изделия

Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым
ферментативно-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ
21.20.23-017-40341780-2021 предназначен для количественного определения
холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме
крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве
диагностического биомаркера уровня содержания липидов, оценки и
обследования результатов биохимии и в качестве вспомогательного средства в
диагностике атеросклероза и контроля за эффективностью терапии.

Функциональные характеристики: функциональное средство в
диагностике. Препараты вводят по методу смешивания и автоматического
считывания.

Назначение и критерии качества

Набор реагентов «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» применяется в
качестве вспомогательного средства в диагностике заболеваний, вызванных
нарушением липидного обмена, совместно с результатами других лабораторных
исследований и клинической картиной пациента.

Противопоказания к использованию

Потенциальная потребность использования: учреждения, лаборатории.
Квалификация персонала: специалисты обученные эксплуатации оборудования
лабораторной диагностики, медицинская лабораторная техника
(флуориметры, фотометры).

Область применения

Область применения: клиническая диагностика.
Область применения: лабораторная диагностика.
Холестерин (липопротеиды) – жироподобные вещества, участвующие в
структуре клеточных мембран. Холестерин содержится во всех клетках человеческого

ООО «Бизнес Медфарм»
11105, г. Москва, Восточное шоссе, 28А
тел.: +7 (855) 10 00013

**Набор реактивов для количественного определения концентрации
ионов калия в сыворотке крови методом
фотометрирования**

«Экспресс-ИОН-калий»
по ТУ 12.13.017-2008 (приказ № 12)
Состав: 1. Компонент 1 (200 порций)
Реактив 1 - 1 флакон (20 мл), Реактив 2 - 1 флакон (20 мл)



К.П. № 2020С **ИВД** Только для in vitro диагностики

Набор реактивов для количественного определения концентрации ионов калия в сыворотке крови методом фотометрирования


«Экспресс-ИОН-калий»
по ТУ 12.13.017-2008 (приказ № 12)
Состав: 1. Компонент 1 (200 порций)
Реактив 1 - 1 флакон (20 мл), Реактив 2 - 1 флакон (20 мл)



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Набор реактивов для количественного определения концентрации ионов калия в сыворотке крови методом фотометрирования применяется для диагностики заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, в частности, для выявления дефицита калия в организме.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор реактивов для количественного определения концентрации ионов калия в сыворотке крови методом фотометрирования применяется для диагностики заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, в частности, для выявления дефицита калия в организме.

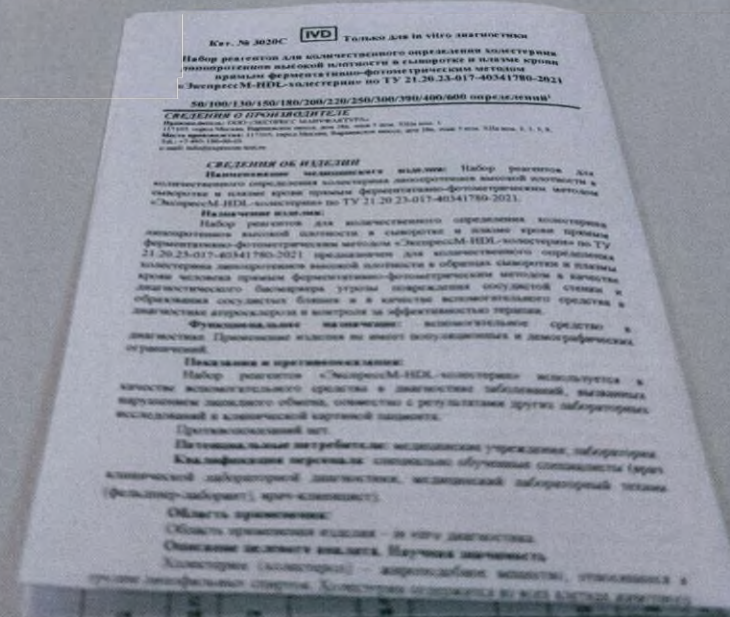

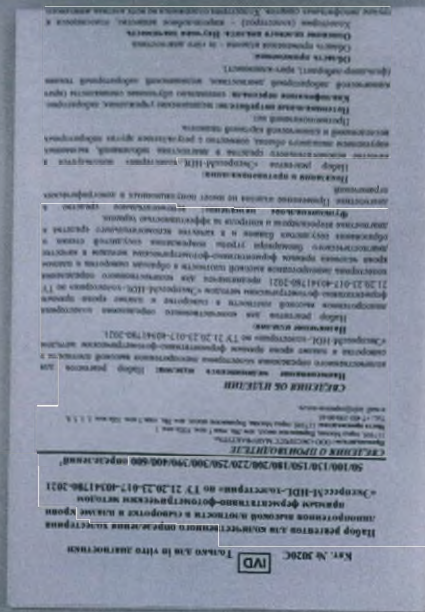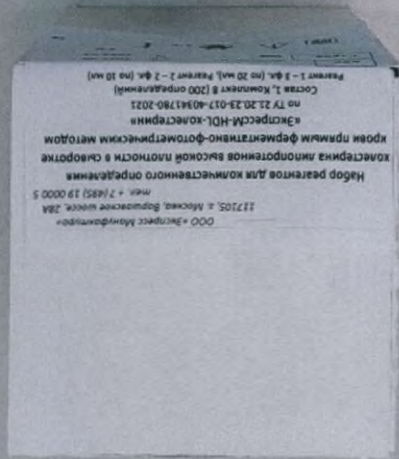

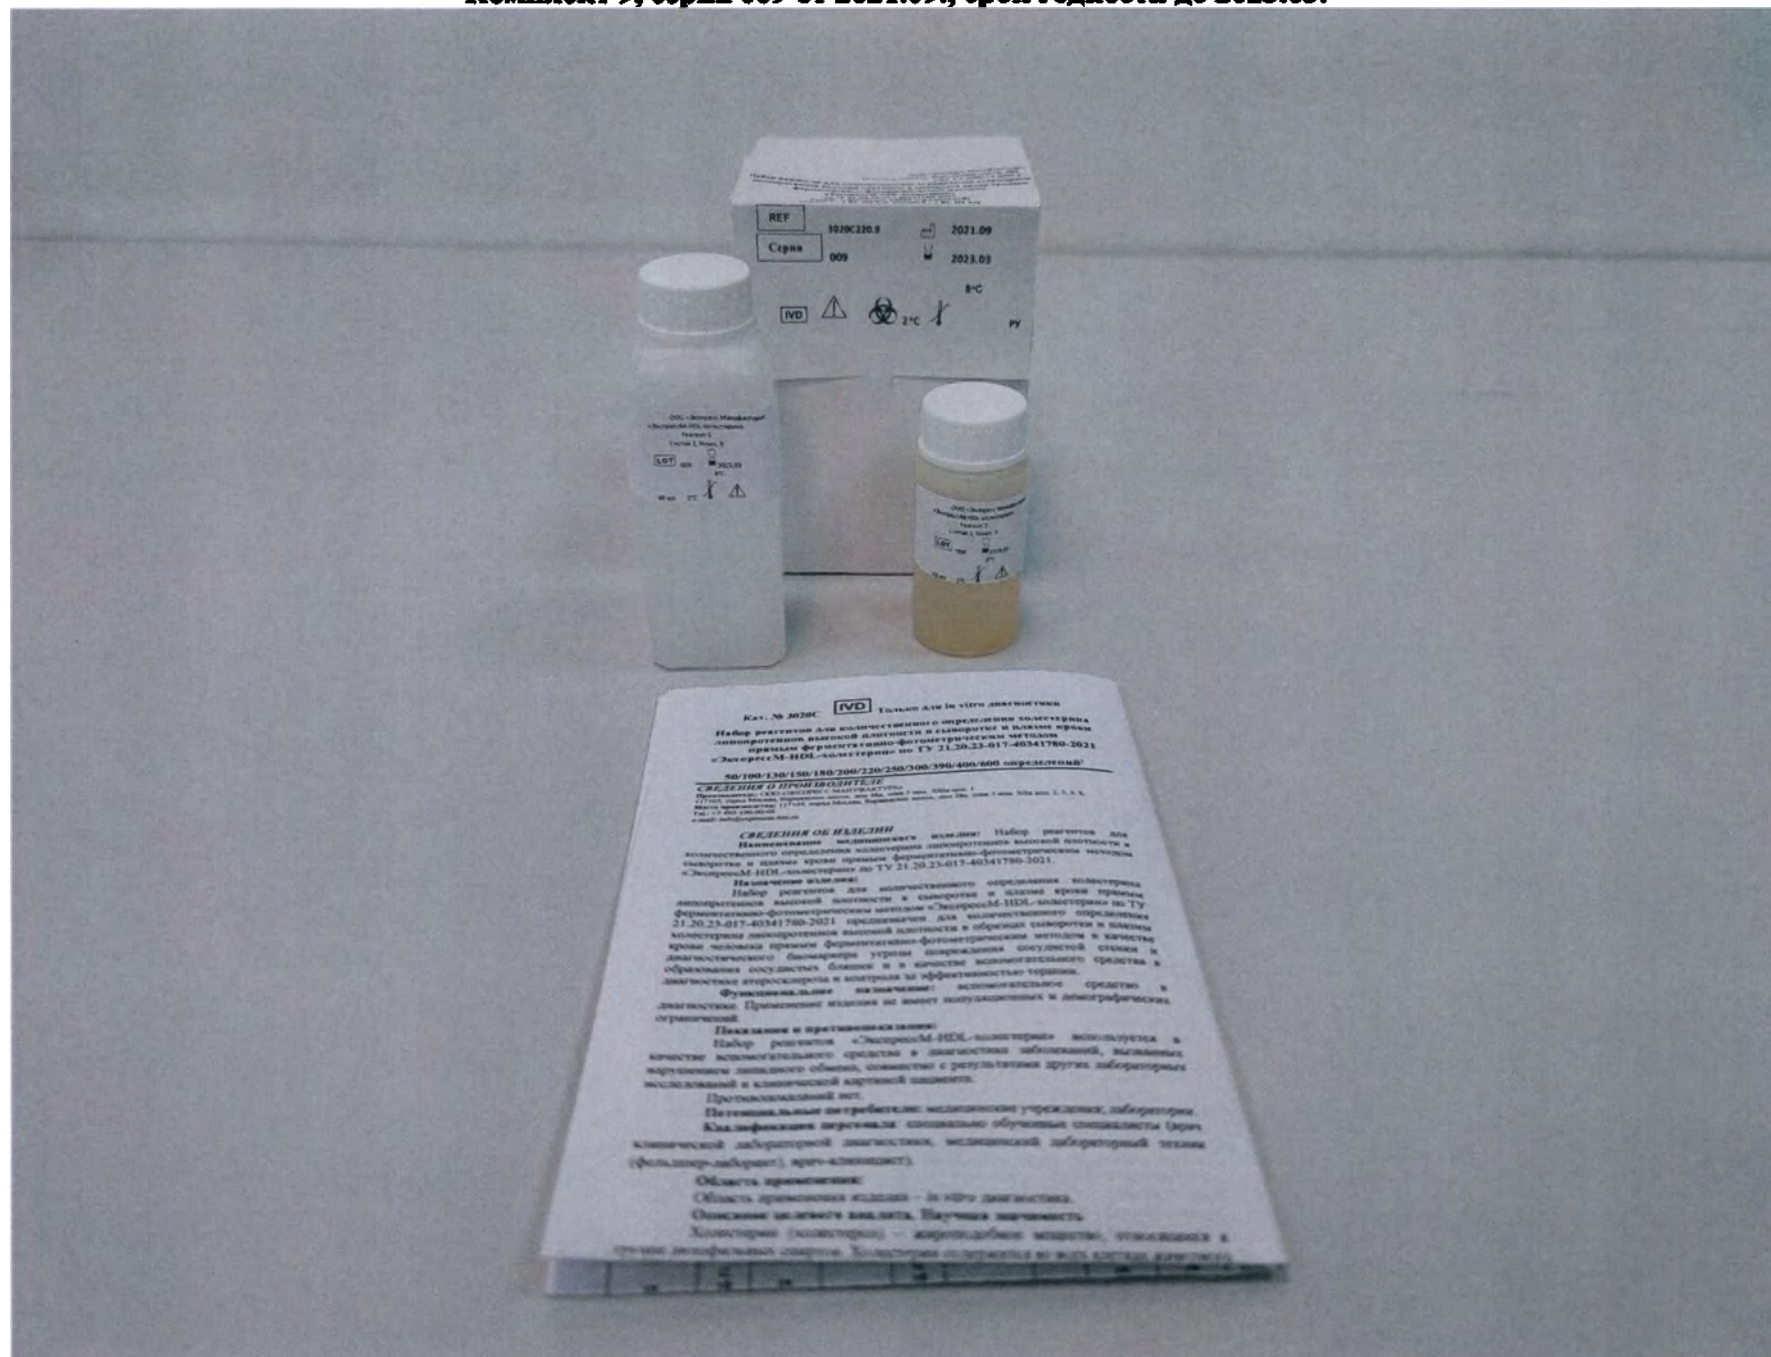

ООО «Эксперт-МедиаТерра»
127135, г. Москва, Ленинский район, ул. Мухоморова, д. 28А
Тел.: +7 (495) 19 0000 5
Факс: +7 (495) 19 0000 5
E-mail: info@expert-media.ru
Сайт: www.expert-media.ru

Набор реагентов для количественного определения токсичности
липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым
ферментативно-фотометрическим методом

«Эксперт-М-НН»-комплект
по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021
Содержит: 1 флакон (120 мл) реактива
Реактив 1 – 1 флакон (120 мл), Реактив 2 – 1 флакон (120 мл)



Кат. № 3028C



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для количественного определения токсичности
липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови
прямым ферментативно-фотометрическим методом
«Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021


№ 100 130 150 180 200 250 300 350 390 400 450 480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

Назначение: набор реагентов для количественного определения токсичности липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021.

Набор реагентов для количественного определения токсичности липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021, предназначен для количественного определения токсичности липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021. Набор реагентов для количественного определения токсичности липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021, предназначен для количественного определения токсичности липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021.

Набор реагентов для количественного определения токсичности липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021, предназначен для количественного определения токсичности липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021. Набор реагентов для количественного определения токсичности липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021, предназначен для количественного определения токсичности липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Эксперт-М-НН»-комплект по ТУ 21.20.23-017-00431780-2021.

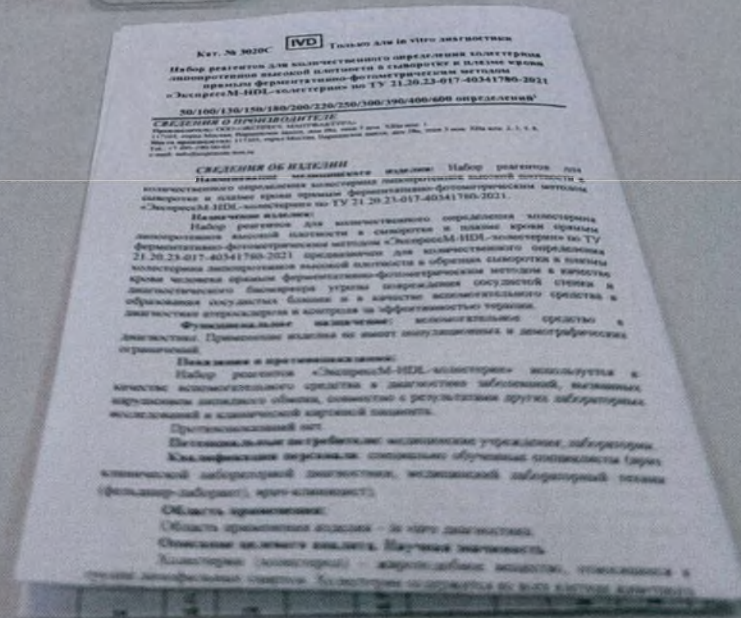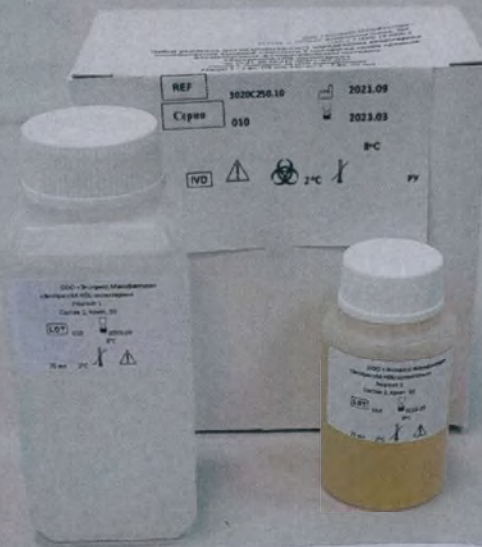

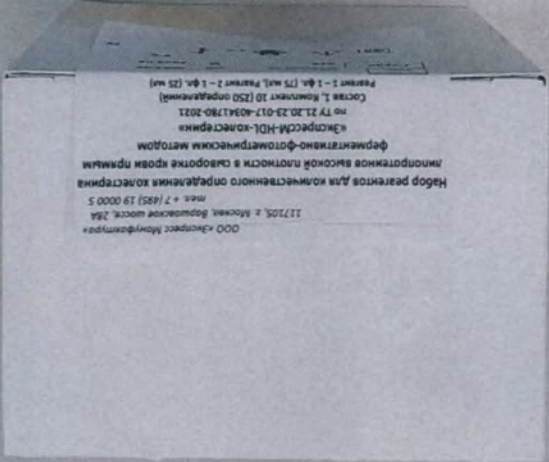

Набор реагентов для колориметрического определения содержания железа в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом

«Экспресс-ИДЛ-кофестрин»
по ТУ 21.23.017-40341780-2021

Только для in vitro диагностики

ИДЛ

Состав: 1, флакончик 10 (250 порций)
Вместит 1 - 1 фла. (75 мл, флакончик 1 - 1 фла. (25 мл))

Назначение, применение

Набор реагентов для колориметрического определения содержания железа в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом

«Экспресс-ИДЛ-кофестрин»
по ТУ 21.23.017-40341780-2021

Состав: 1, флакончик 10 (250 порций)
Вместит 1 - 1 фла. (75 мл, флакончик 1 - 1 фла. (25 мл))

ООО «Вектор-Биофарм»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 26А
тел. +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для колориметрического определения содержания железа в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом

«Экспресс-ИДЛ-кофестрин»
по ТУ 21.23.017-40341780-2021

Только для in vitro диагностики

ИДЛ

Состав: 1, флакончик 10 (250 порций)
Вместит 1 - 1 фла. (75 мл, флакончик 1 - 1 фла. (25 мл))

ООО «Вектор-Биофарм»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 26А
тел. +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для колориметрического определения содержания железа в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом

«Экспресс-ИДЛ-кофестрин»
по ТУ 21.23.017-40341780-2021

Только для in vitro диагностики


ИДЛ


Состав: 1, флакончик 10 (250 порций)
Вместит 1 - 1 фла. (75 мл, флакончик 1 - 1 фла. (25 мл))

ООО «Вектор-Биофарм»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 26А
тел. +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для колориметрического определения содержания железа в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом

«Экспресс-ИДЛ-кофестрин»
по ТУ 21.23.017-40341780-2021

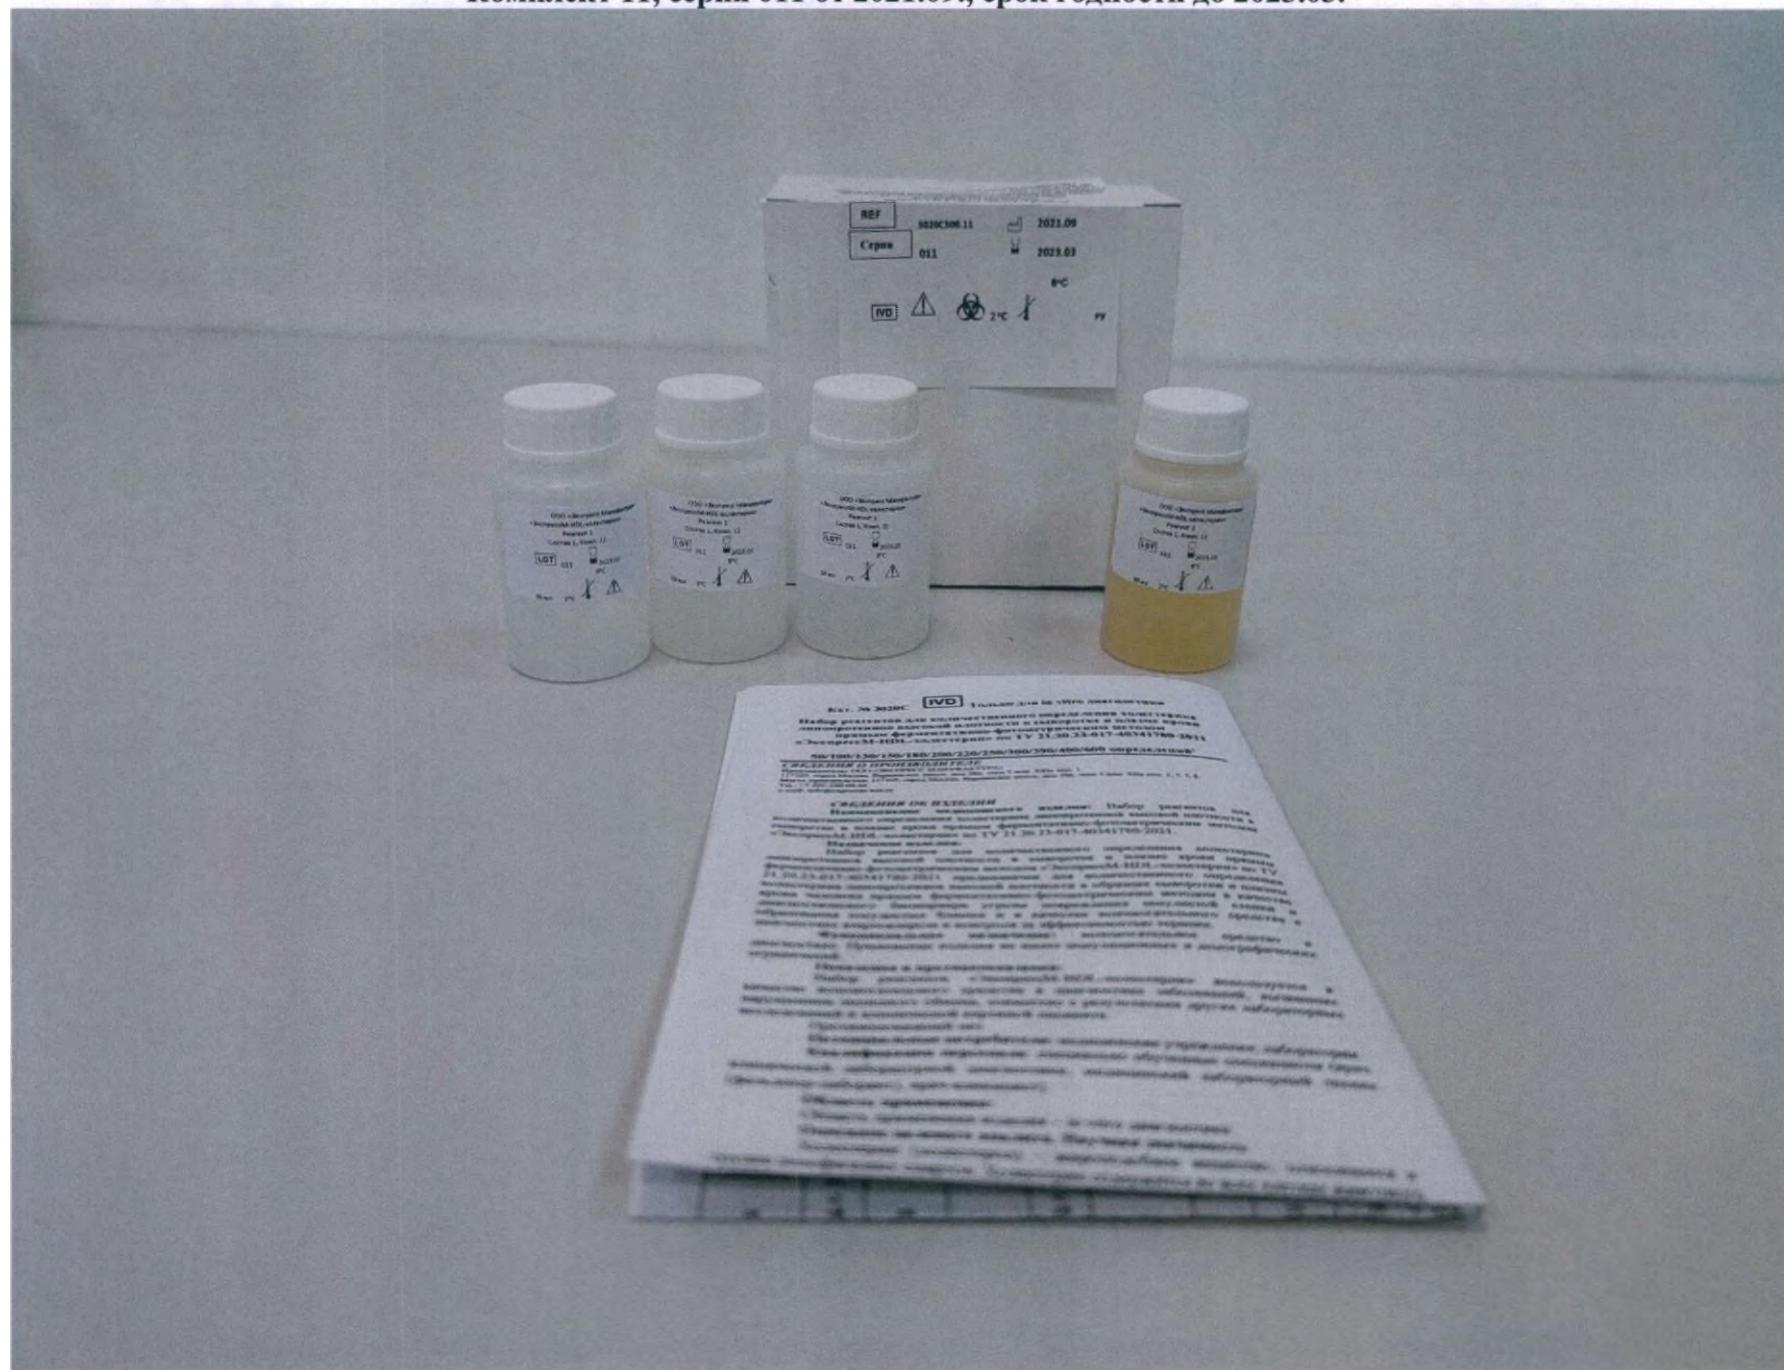

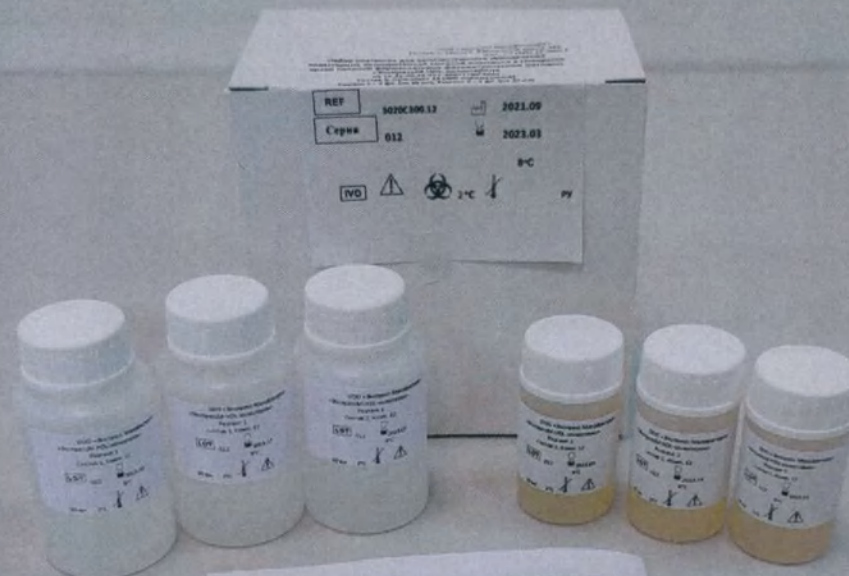

Кит. № 3020C **IVD** Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина
прямым ферментативно-фотометрическим методом
«Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

50/100/130/150/180/200/230/250/300/390/400/600 определяемых

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 «Экспресс-M-HDL-холестерин» - набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом. Срок годности: 12 месяцев. Условия хранения: 2-8°C. Место хранения: в холодильнике. Адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1. Контакт: 8 (495) 790-1000.

СРЕДСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Назначение и применение
 Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом. Предназначен для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве вспомогательного средства в диагностике атеросклероза и контроля за эффективностью терапии. **Функциональное назначение:** вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не имеет ограничений и противопоказаний.

Пакетирование и протравка
 Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» используется в качестве вспомогательного средства в диагностике заболеваний, вызванных нарушением липидного обмена, совместно с результатами других лабораторных исследований и клинической картиной пациента.

Противопоказания к применению
 Противопоказания к применению: медицинские учреждения, лаборатории. **Квалификация персонала:** специально обученные специалисты (врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист).

Область применения
 Область применения изделия - in vitro диагностика.

Описание целевого анализа. Научная значимость.
 Холестерин (холестерол) - жирорастворимое вещество, от которого зависит липидный обмен. Холестерин содержится во всех клетках животного

Набор реагентов для количественного определения колестерина
лабораториями высокой плотности в сыворотке и плазме крови
прямым ферментативным-фотометрическим методом
«Liposcreen-M-HDL-колестерин» по TY 21.20.23-017-40341796-2024

50-106-130-150-180-200-220-250-300-350-400-500 www.mos.ru
СЕРВИС ДИСТРИБЮТОВ
 177-010, оптовая Магистр, Эксплуатация авто, для 10, 15, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817

CHALLENGE OF WILDLIFE


[illegible]


Функциональная архитектура: функциональные элементы и их взаимодействие. Функциональная структура: функциональные блоки и их взаимодействие.

Показание к применению:
Набор реактивов «Chromalab 808» предназначен для определения в каталитических реакциях присутствия в газовой смеси углеводородов, содержащих ароматические заместители, с помощью газовой хроматографии.

Противопоказан при:
Печеночная недостаточность, заболевания сердечно-сосудистой системы,
Клинически выраженные заболевания желудочно-кишечного тракта,
заболевания мочеполовой системы, заболевания эндокринной системы
(гипотиреоз), при беременности.

Область транснационального
Сферы транснационального — в сфере транснационального
Область транснационального — в сфере транснационального
Культура транснационального — в сфере транснационального

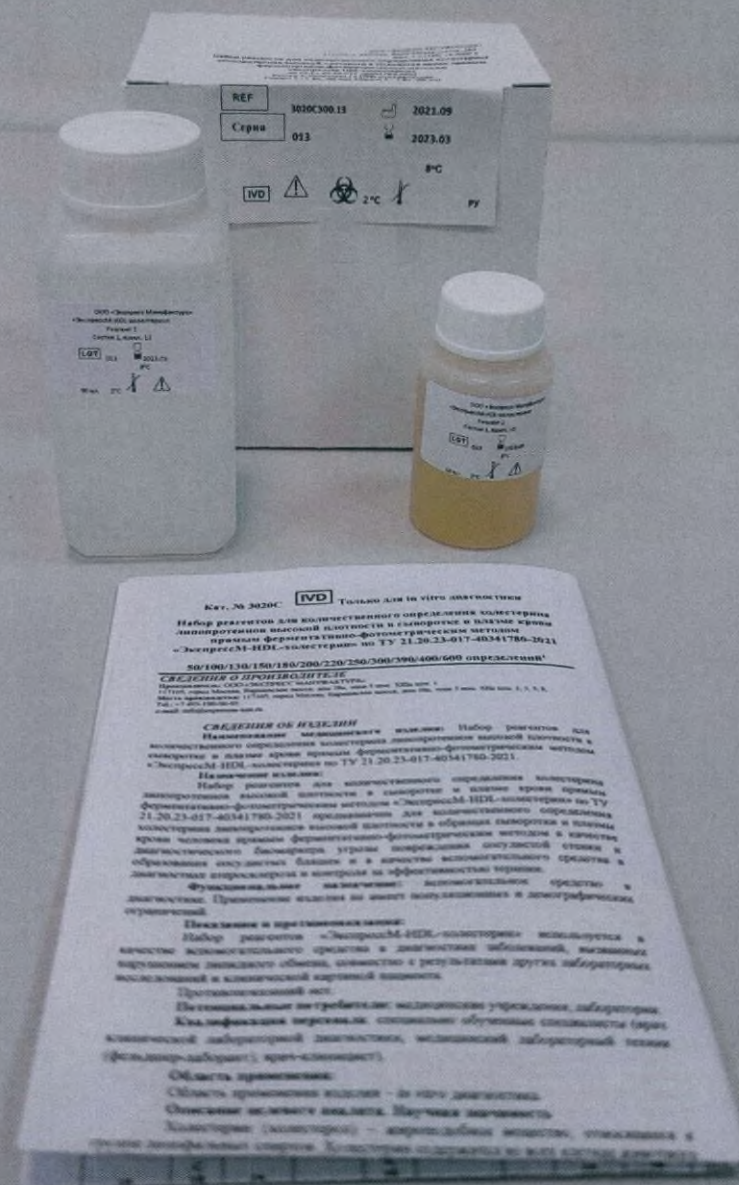

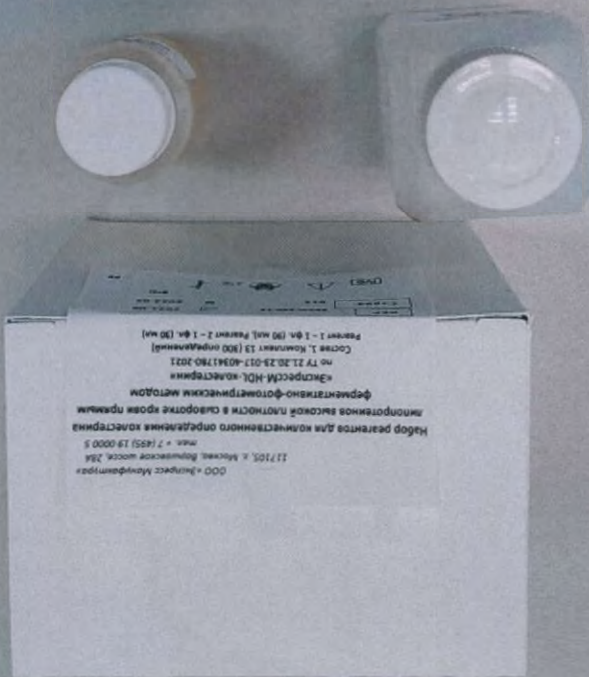KAT. No 3020C TOLMAN AND DE VITO JOURNAL OF THE

QAI

Исторический вид хозяйственного общества, основанного на личном участии в хозяйственной деятельности и на праве собственности на имущество.

«Знаменский МДЛ-хотел» № 17 21.20.25-017-40341780-2021

50/100/130/150/180/200/220/250/300/390/400/600 опрелелени

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Исследования выполнены в соответствии с программой государственного задания на проведение научных исследований в области фундаментальной науки.

1002-6248/04/110-0702\$15.00/0

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

10.23.017-40161780-2021

...the ...

1. *Abstract* (100 words or less) – This section should be placed at the beginning of the paper, after the title page. It should briefly summarize the purpose of the study, the methods used, the results obtained, and the conclusions drawn. It should be written in a clear, concise, and objective manner.

Journal of Management Education 32(10)

(continued from page 6)


См. также: [Классификация систем управления качеством](#)



Кроме того, в работе [1] описаны алгоритмы построения оптимальных планов управления для систем с нелинейными объектами и нелинейными ограничениями на управление.


(continued from page 6)


(Author's correspondence address: Dr Peter Hain, 100, Victoria Road, London, W12 0PL, UK. Tel: 020 8996 9000. Fax: 020 8996 9001. E-mail: peter.hain@hain.co.uk.)


THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

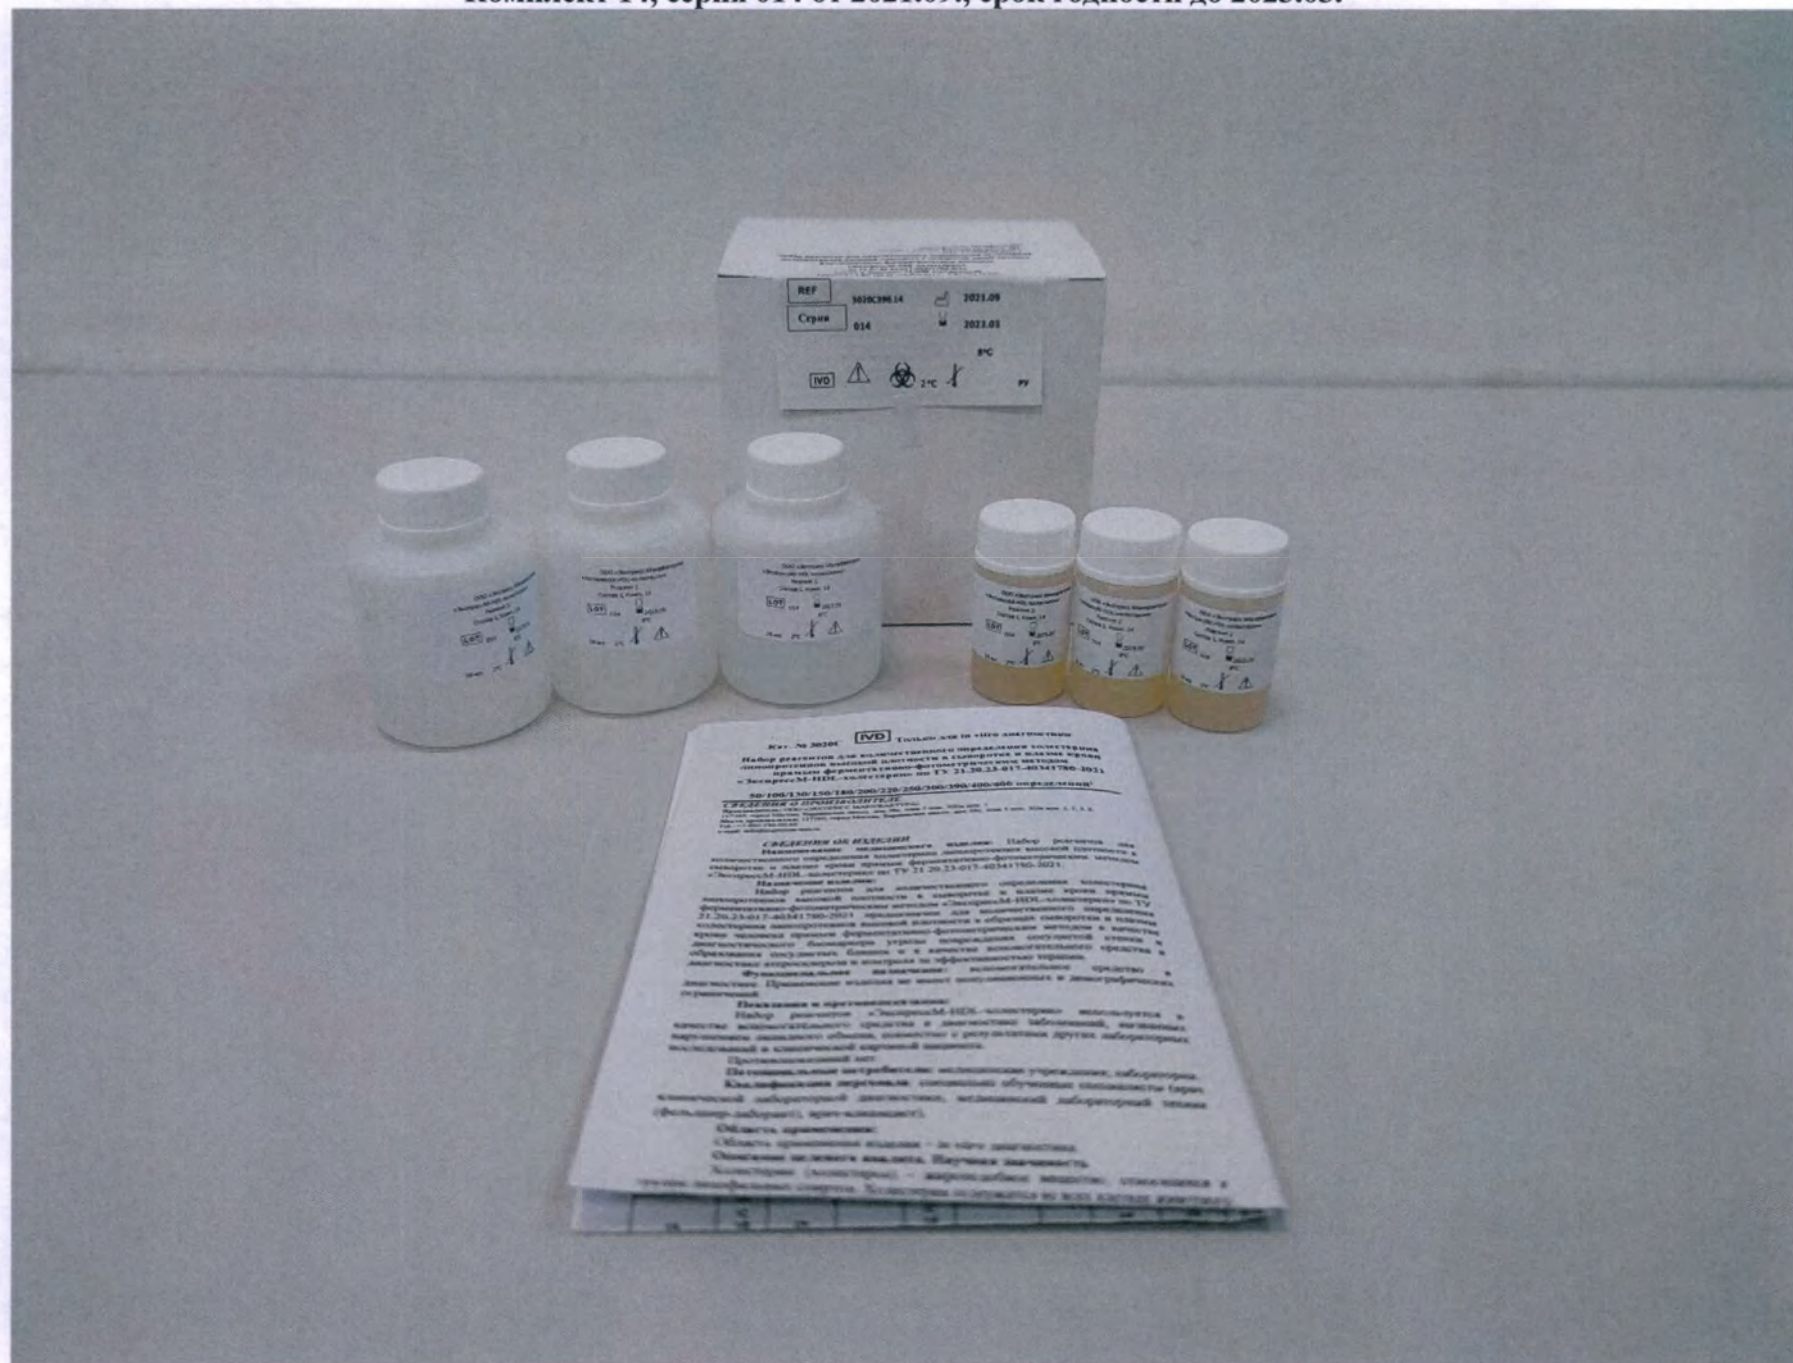

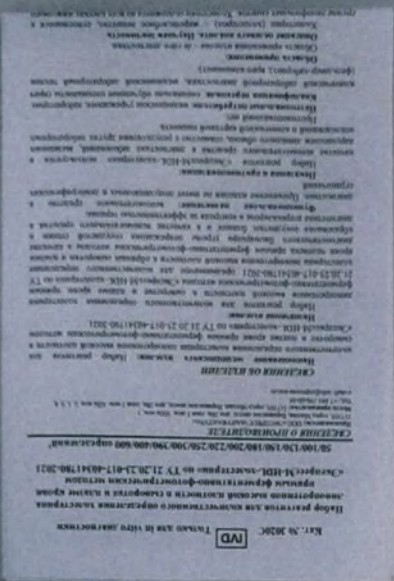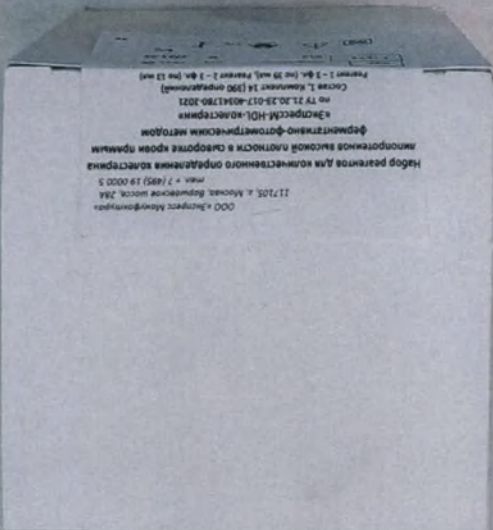

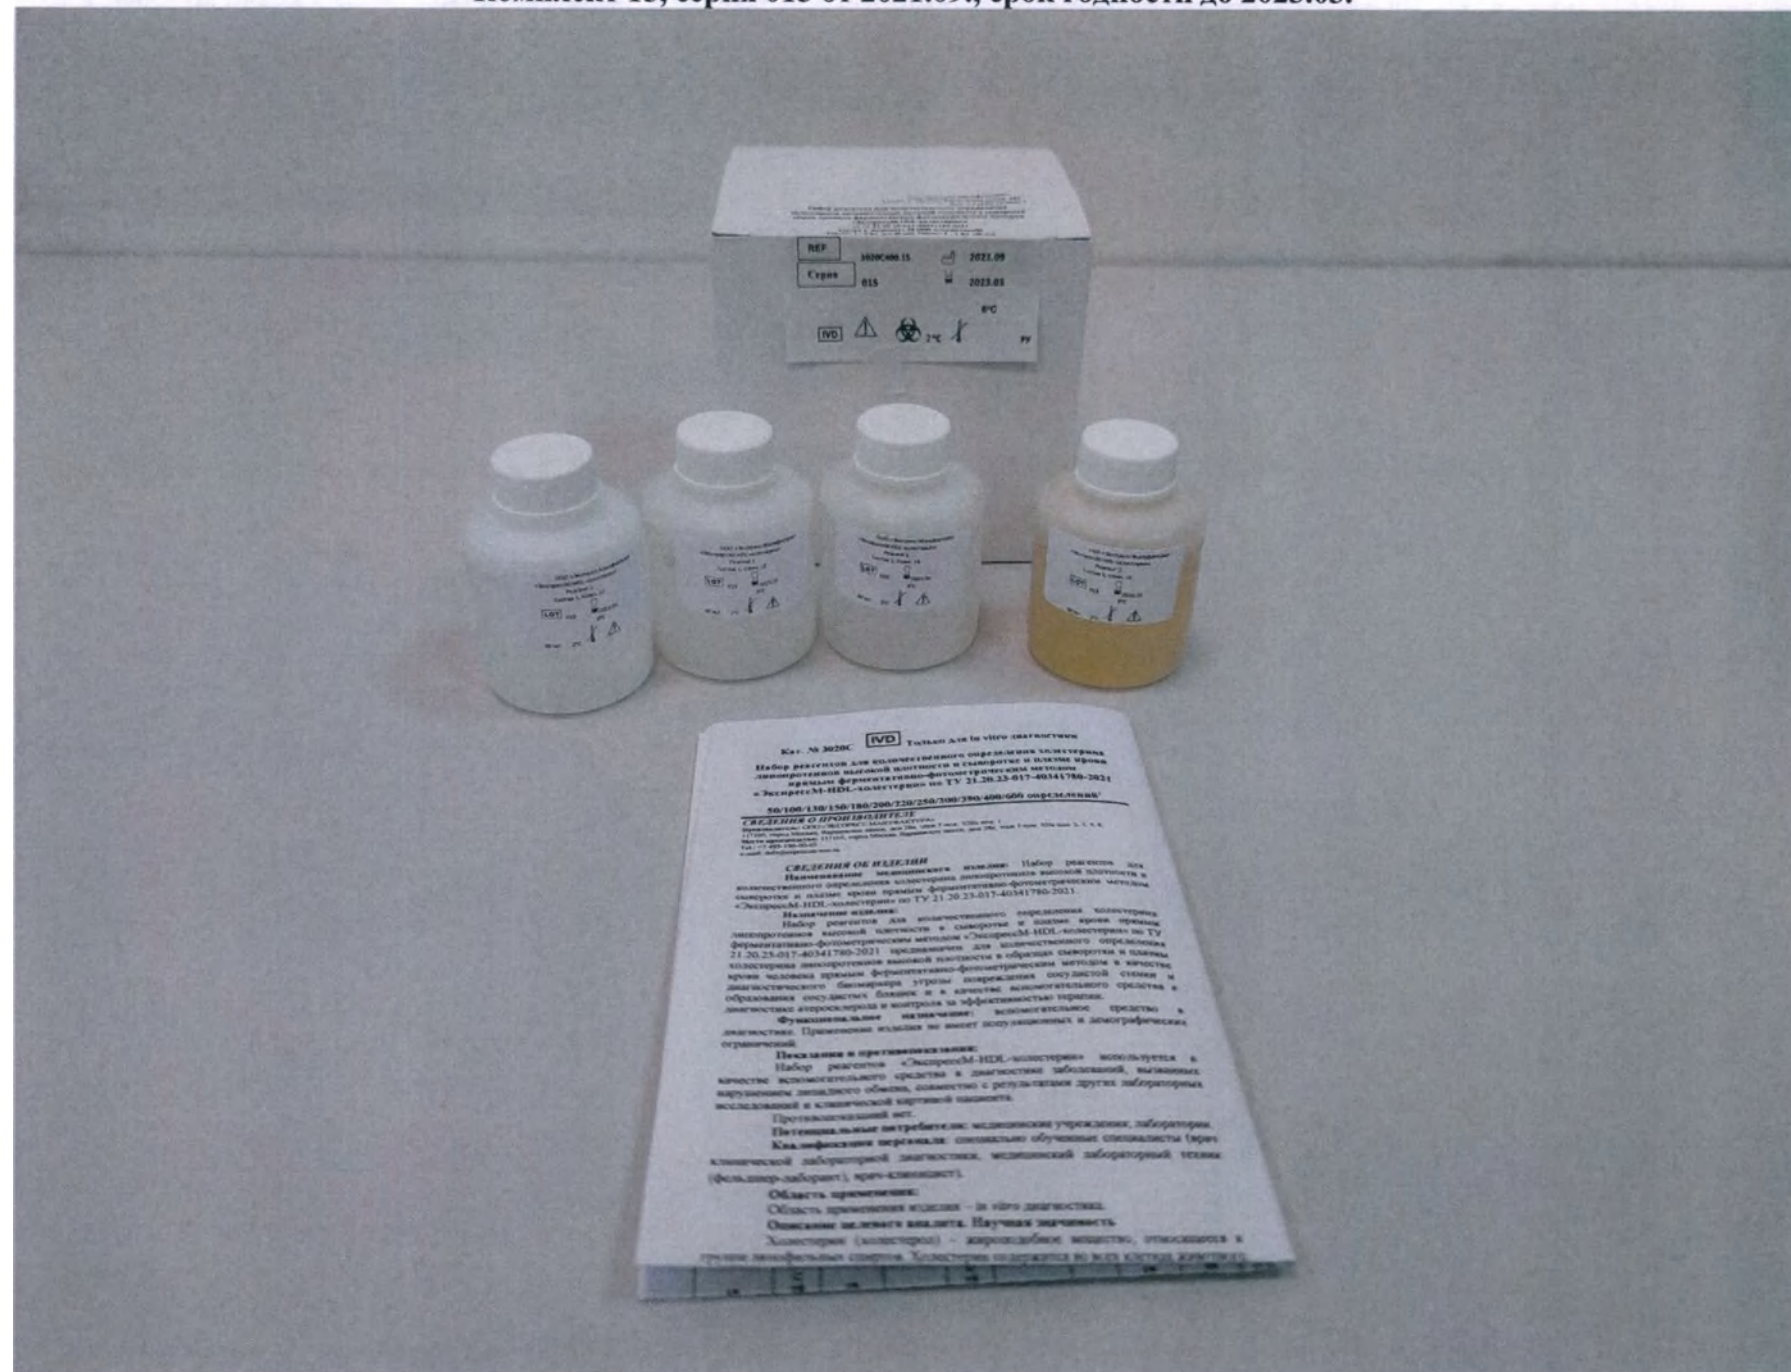

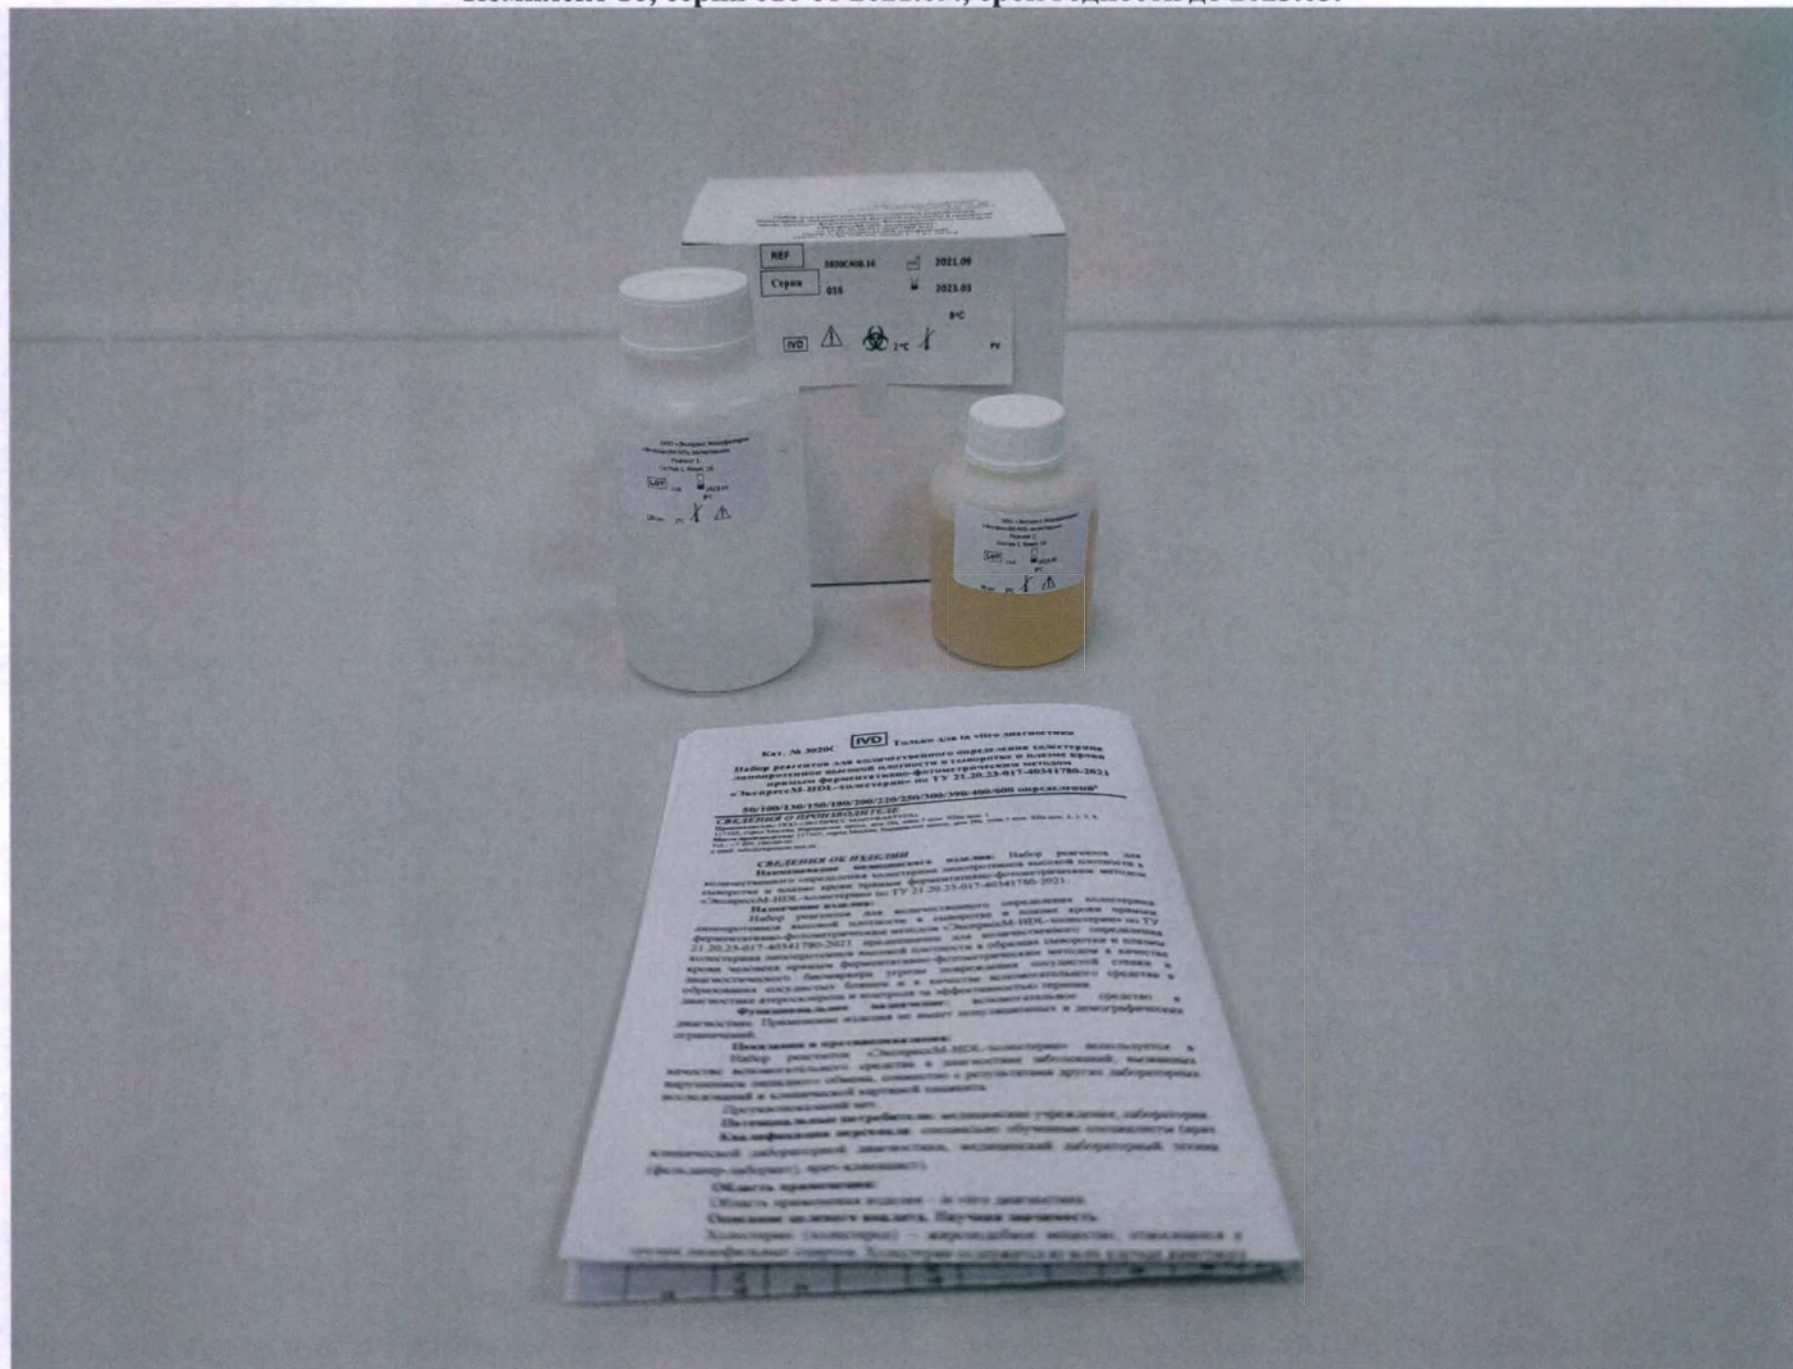

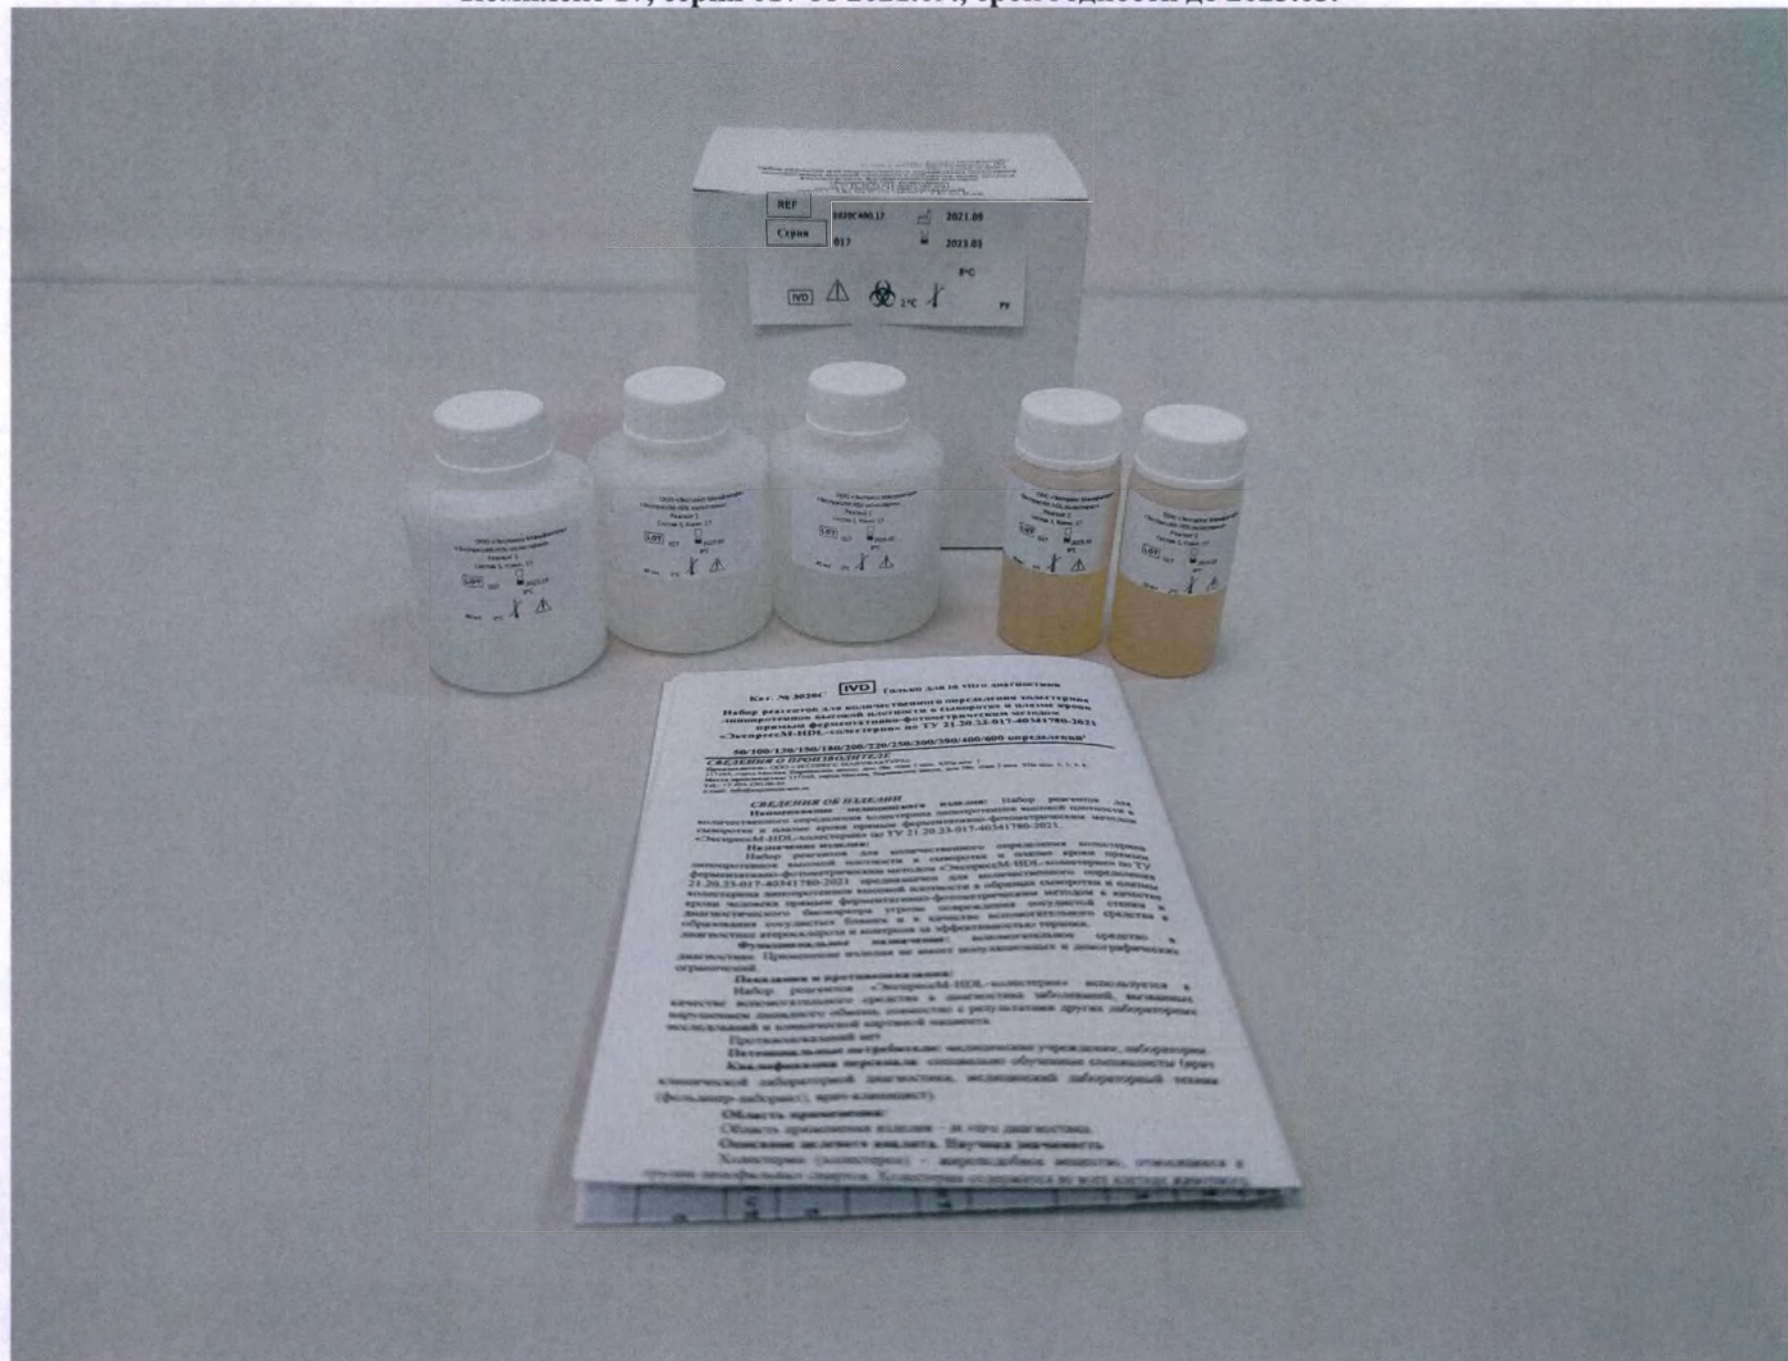



000 «Антияс» (ООО)
 117036 г. Москва, Рязанский проезд, 28А
 Тел./факс: (495) 911-11-11
 e-mail: info@antia.ru

Кат. № 20200.  Издание для библиотечного использования

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20540


1776/1919-1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736


А) не соответствует. КЭЭ производят в основном из отходов от производства



Вопросы, связанные с применением методов исследования, рассмотрены в работе [1].

Вопросы, связанные с организацией работы, являются одними из наиболее актуальных в настоящее время. В связи с этим в настоящее время в нашей стране проводится большая работа по изучению и внедрению передового опыта работы в различных отраслях народного хозяйства. В этой работе принимают участие многие специалисты, в том числе и работники органов государственного управления. В настоящее время в нашей стране проводится большая работа по изучению и внедрению передового опыта работы в различных отраслях народного хозяйства. В этой работе принимают участие многие специалисты, в том числе и работники органов государственного управления.

(Chairman's appointment)
The Chairman has been appointed by the Government.
The Chairman has been appointed by the Government.

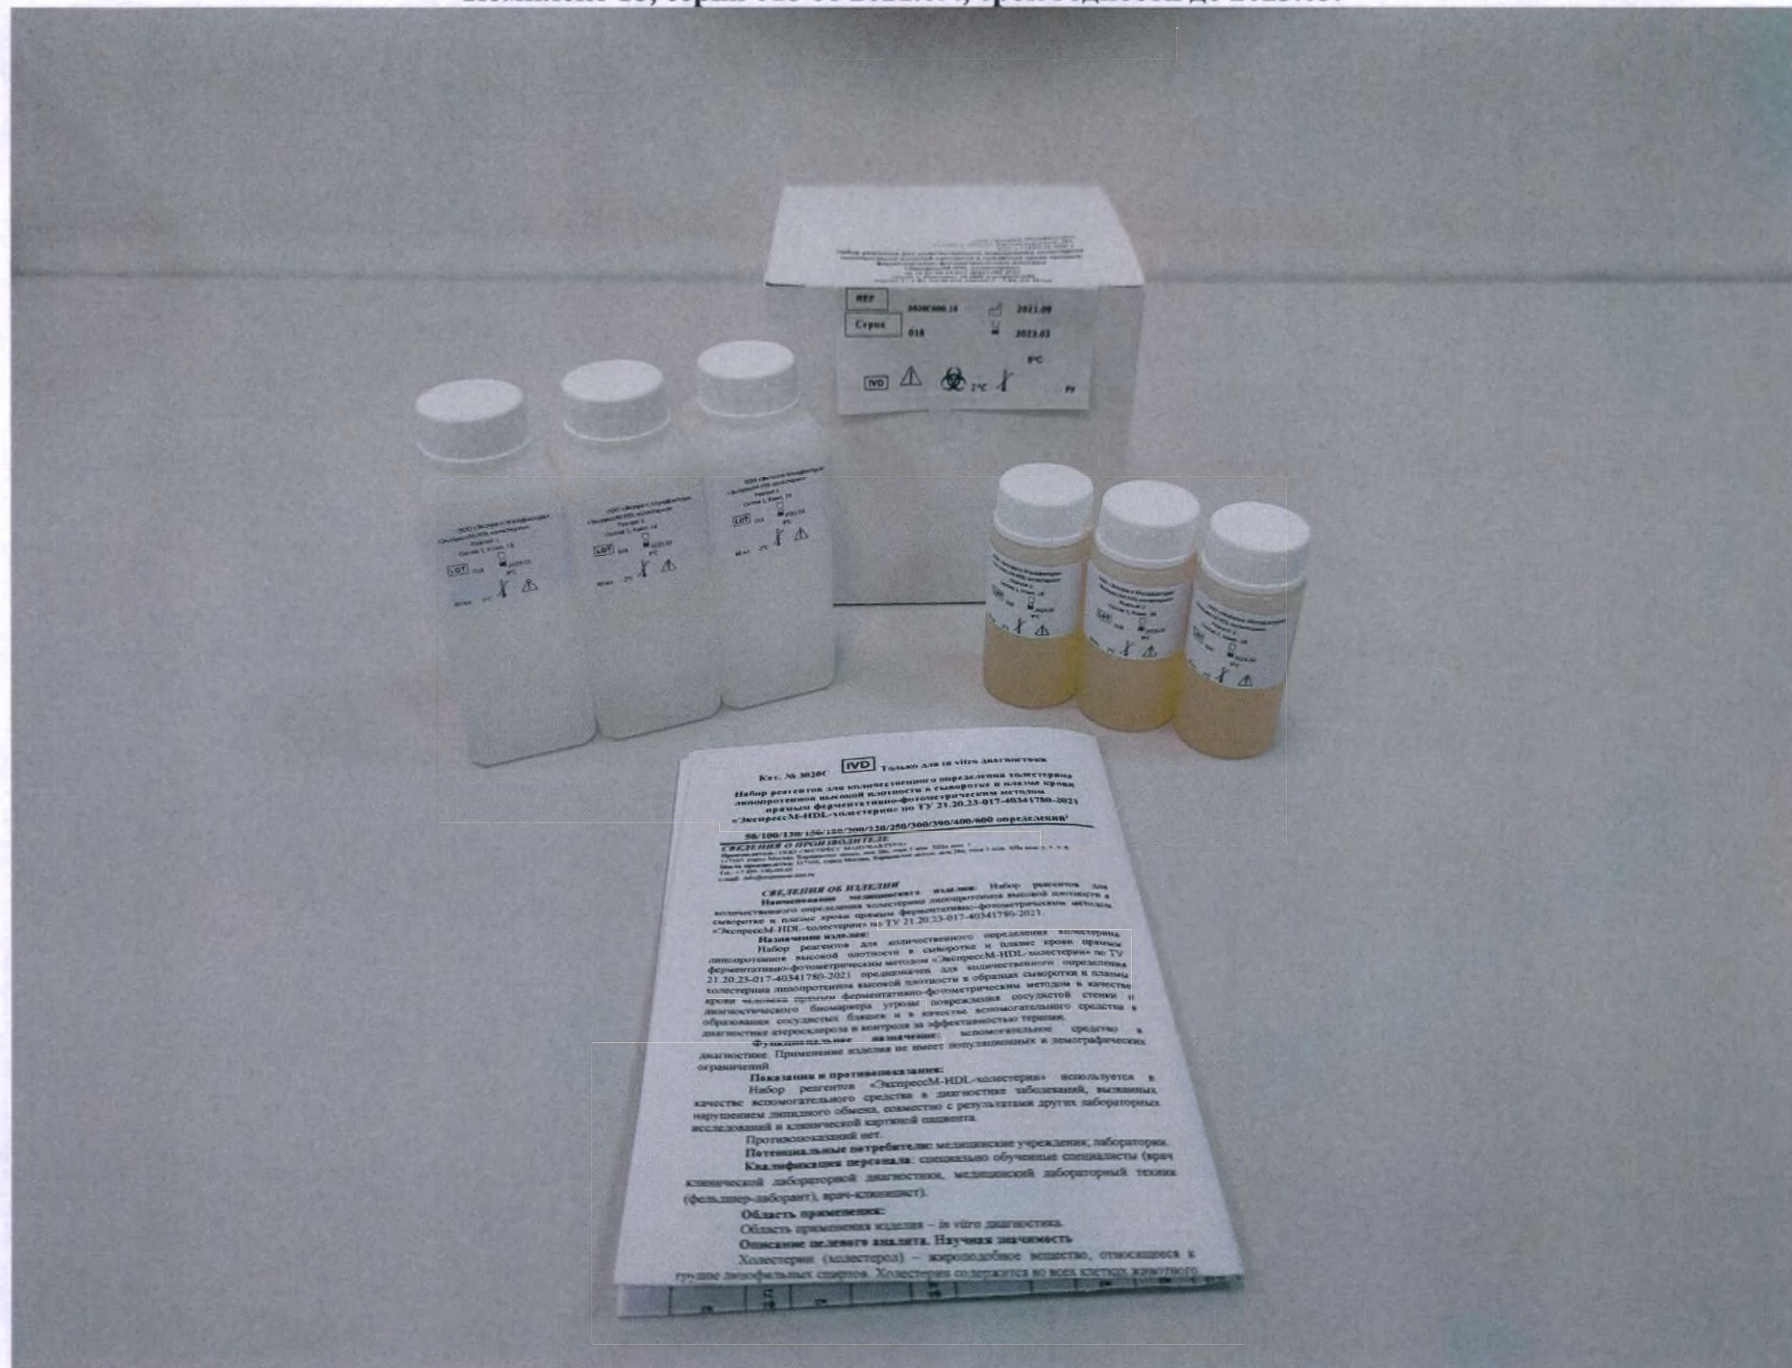

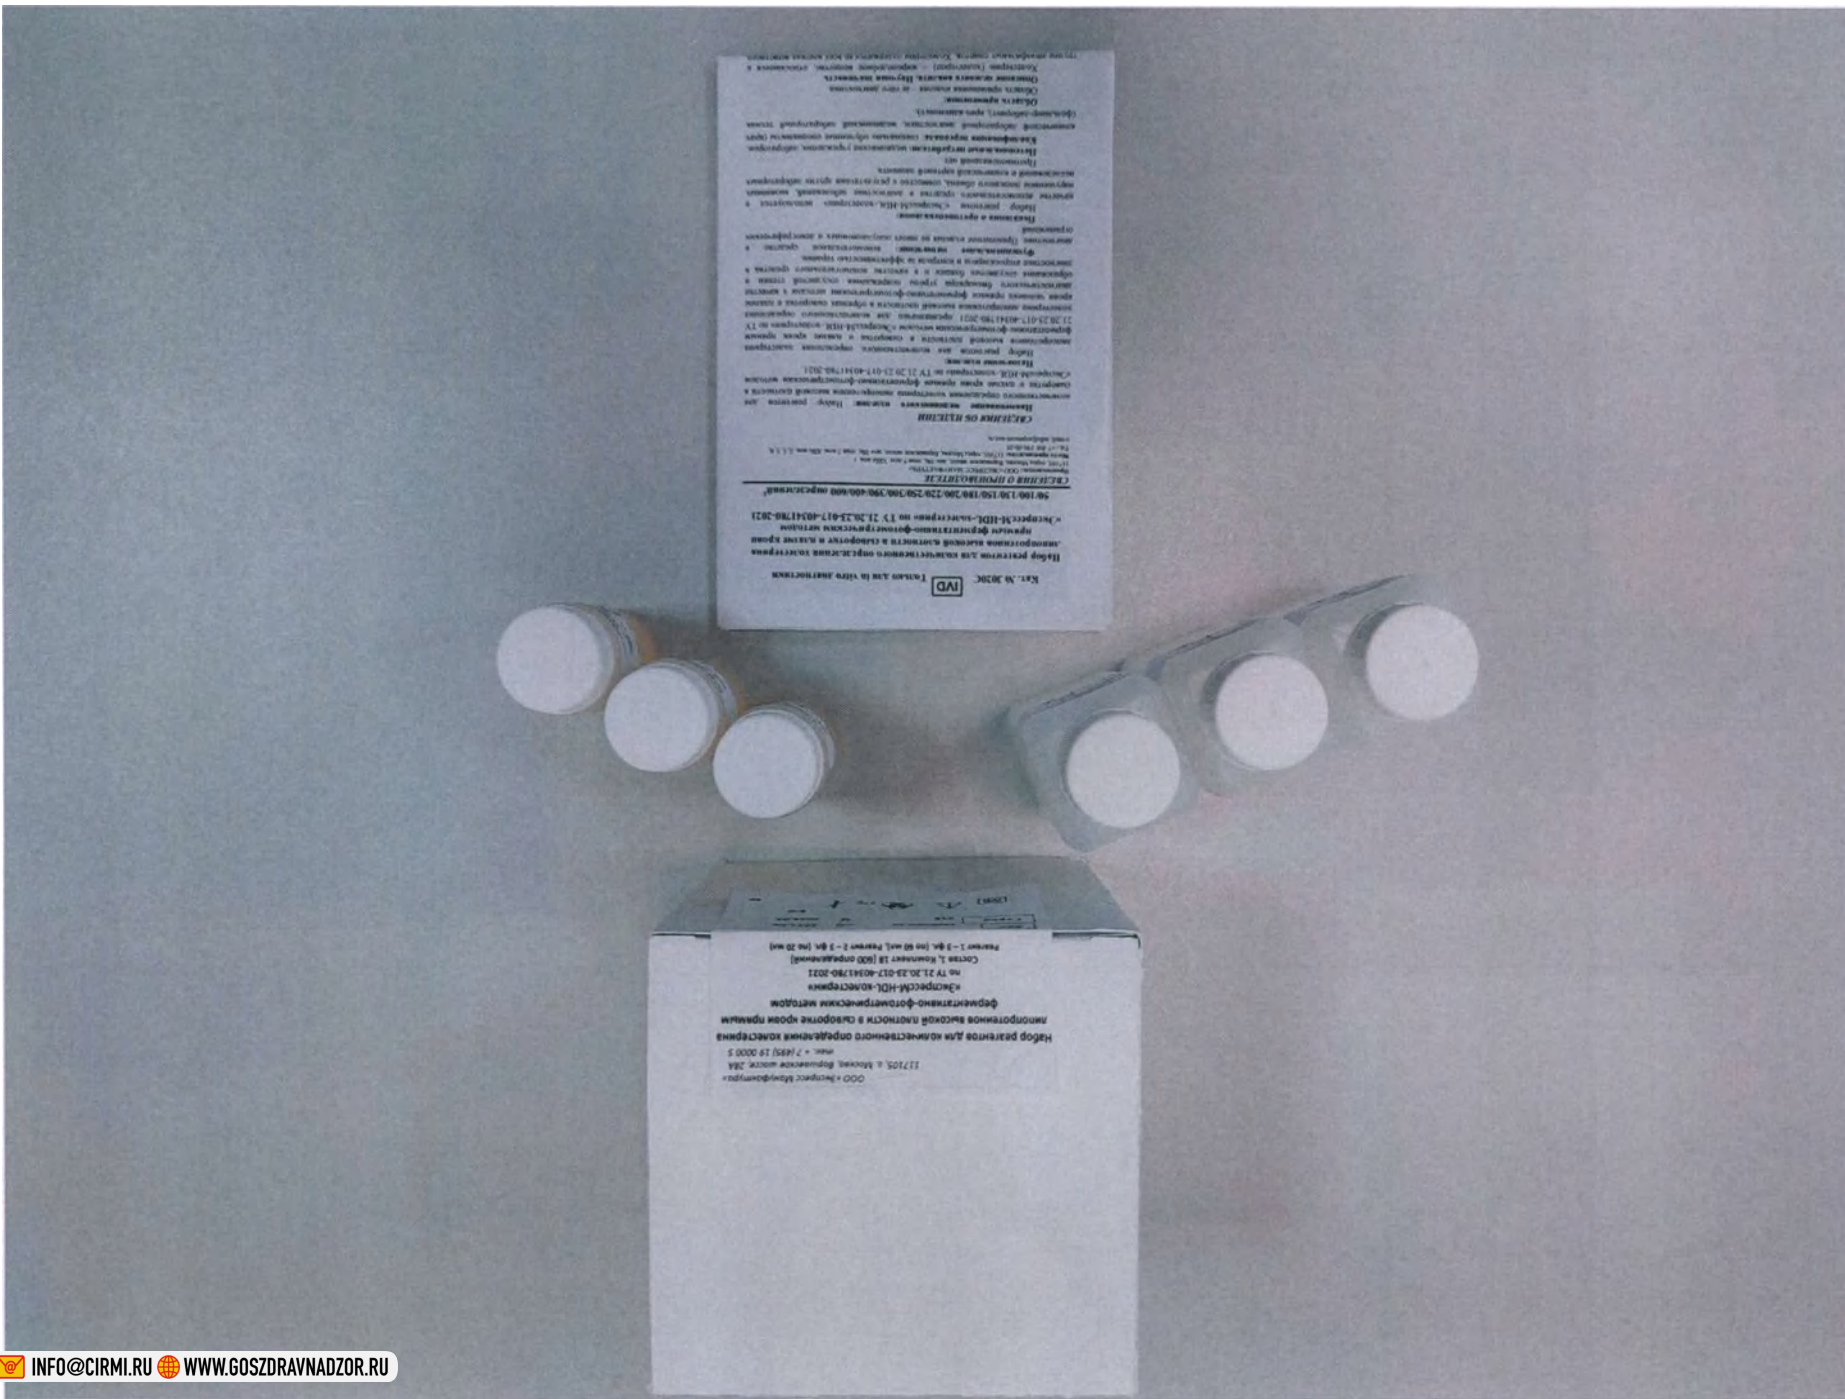

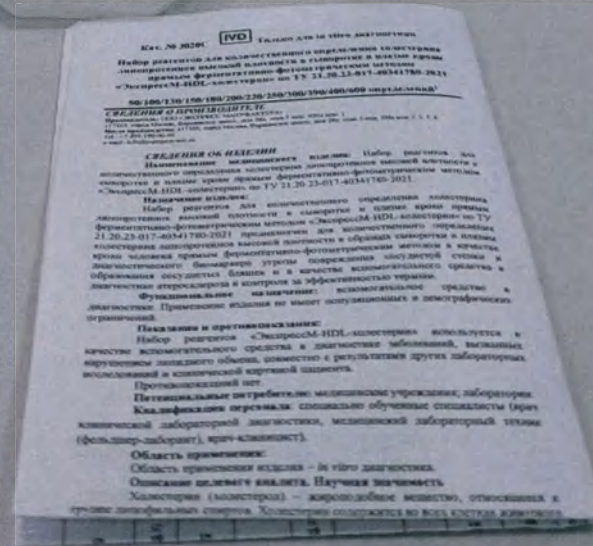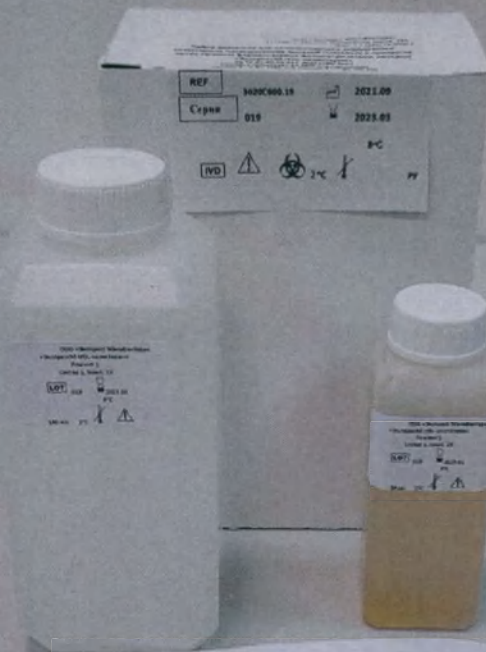

Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-НД-холестерин»

3


Calculation of the Relative


1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Journal of Management Education 30(6)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

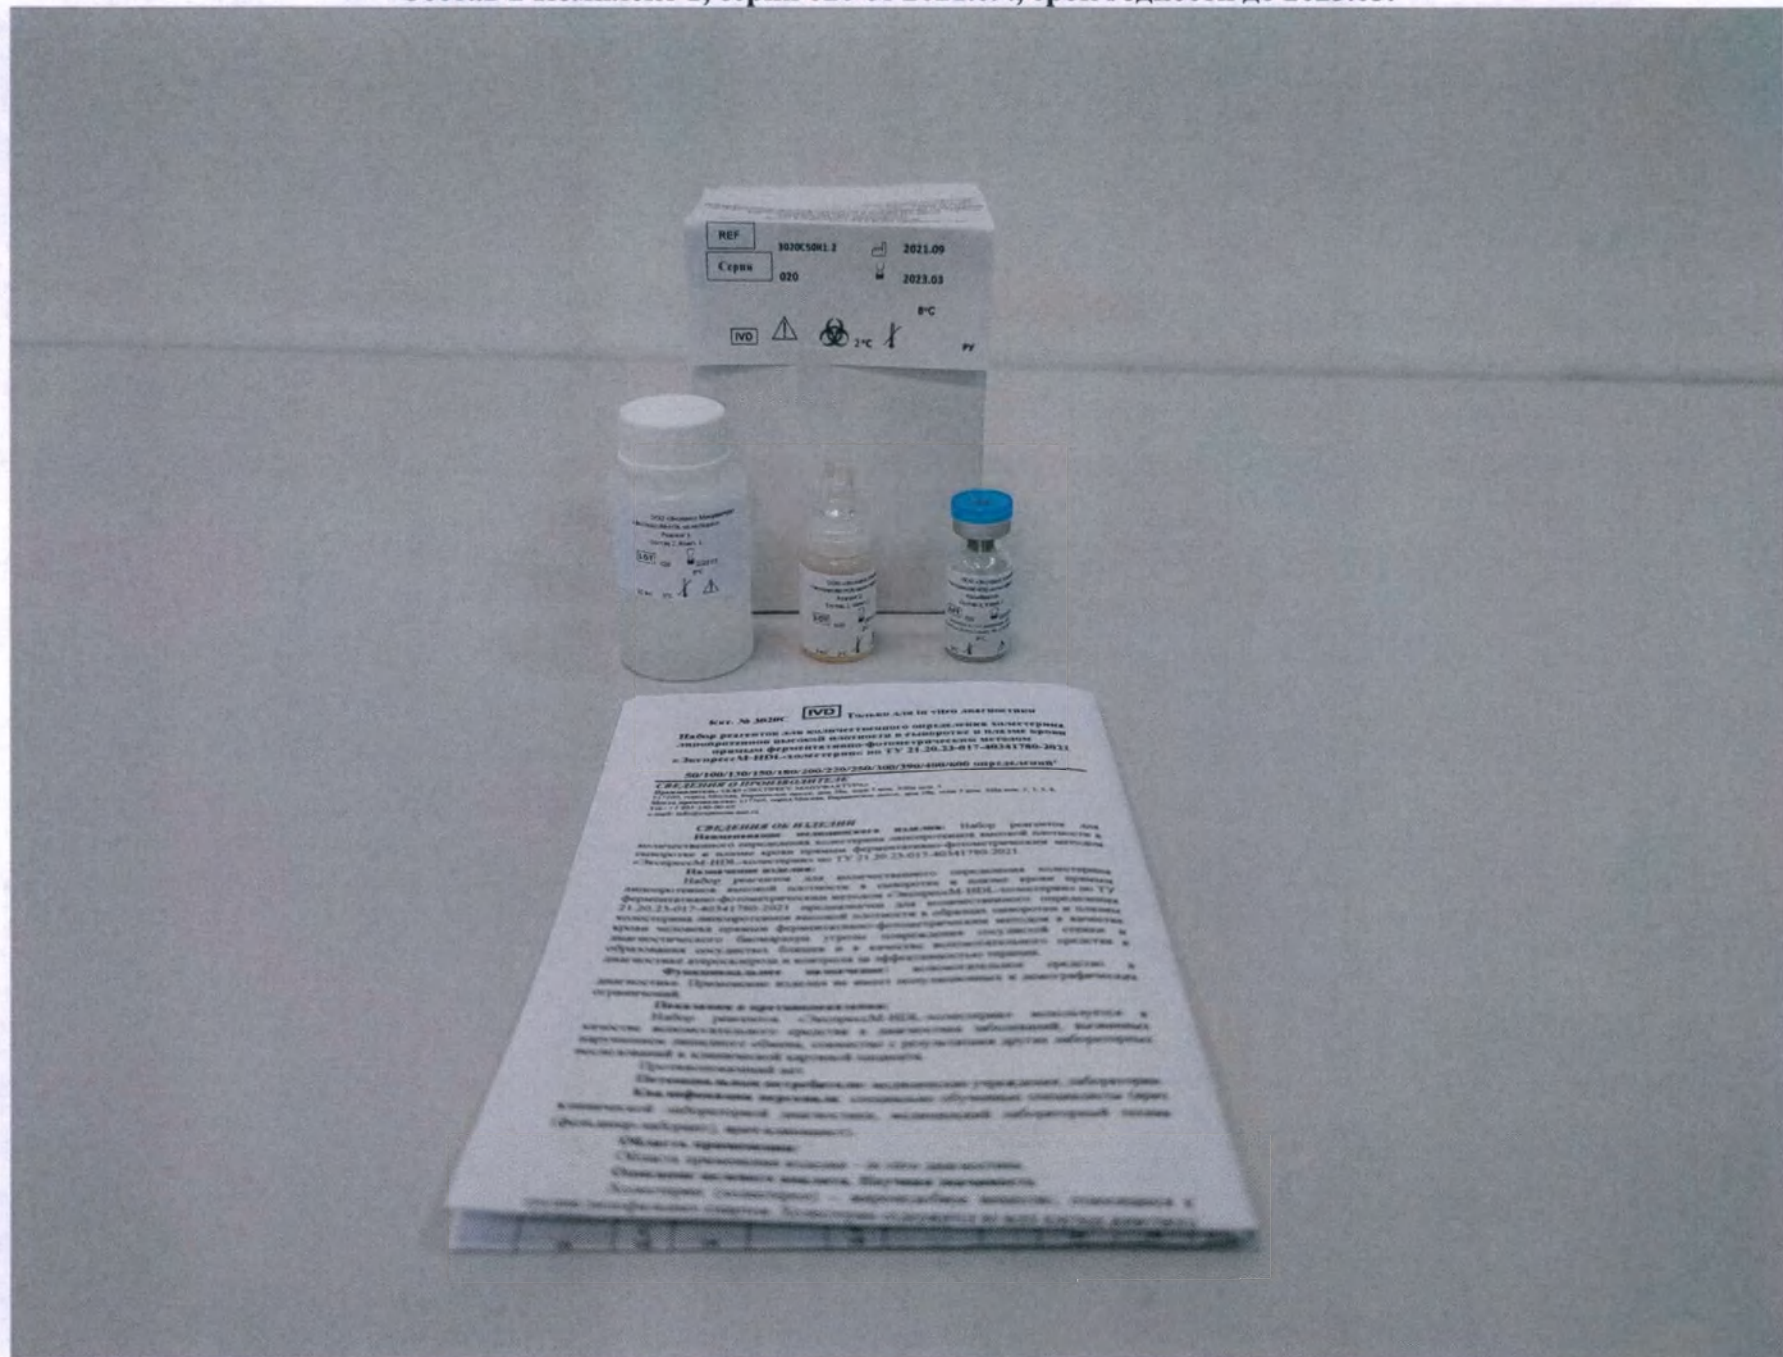

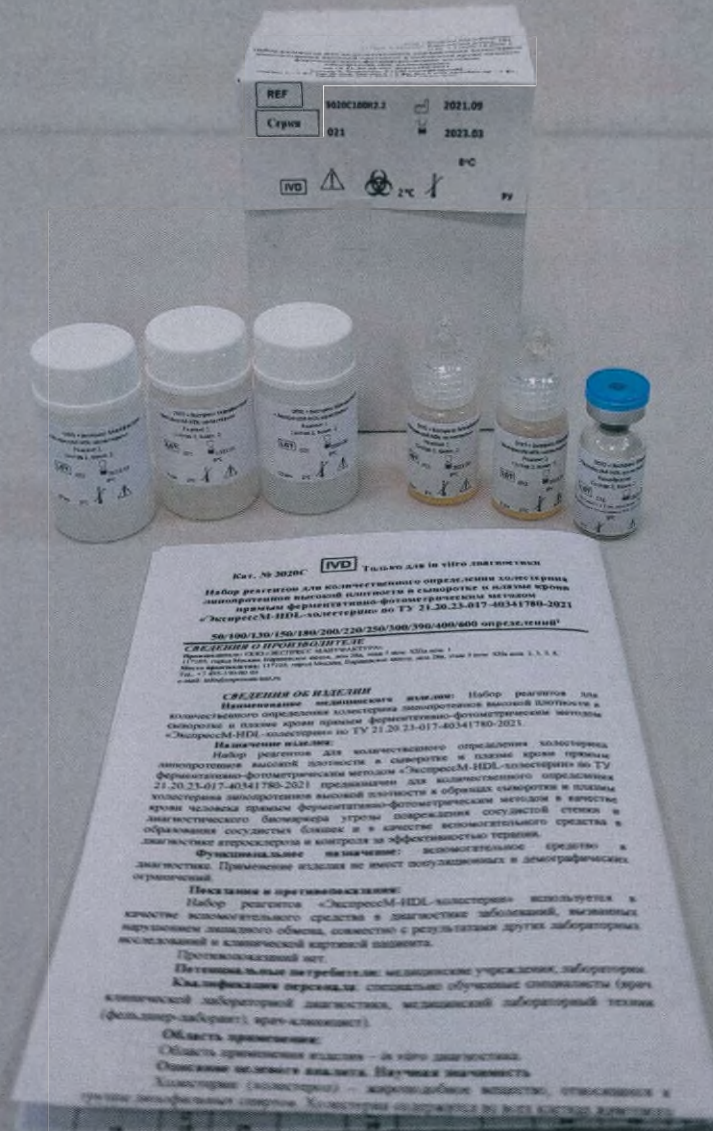

ООО «Биртек Фармгрупп»
117205, г. Москва, Бульварное шоссе, 25А
тел. +7 (495) 19 0000 5
факс +7 (495) 19 0000 6

**Набор реагентов для количественного определения концентрации
липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым
флуоресцентно-фотометрическим методом**

«Экспресс-НДЛ-кодекстерин»
по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021
Серия 1, Количество 2 (100 порционных)
Реактив 1 – 5 мл (по 10 мл), Реактив 2 – 2 мл (по 5 мл), Калибратор – 1 флакон
Итого, реактивов в наборе 8 порционных



Кит: № 30/01С **ИД** Только для in vitro диагностики

**Набор реагентов для количественного определения концентрации
липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым
флуоресцентно-фотометрическим методом**
«Экспресс-НДЛ-кодекстерин» по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021


СЕРТИФИКАТ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
№ 106/130/180/200/230/260/300/380/400/460/490/500/540/560/580/600/620/640/660/680/700/720/740/760/780/800/820/840/860/880/900/920/940/960/980/1000

Исходный материал «Экспресс-НДЛ-кодекстерин» предназначен для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом. Реактивы «Экспресс-НДЛ-кодекстерин» по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021 предназначены для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом. Калибратор «Экспресс-НДЛ-кодекстерин» по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021 предназначен для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом.

Назначение и применение
«Экспресс-НДЛ-кодекстерин» предназначен для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом. Реактивы «Экспресс-НДЛ-кодекстерин» по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021 предназначены для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом. Калибратор «Экспресс-НДЛ-кодекстерин» по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021 предназначен для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом.

Важные и специальные указания
«Экспресс-НДЛ-кодекстерин» предназначен для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом. Реактивы «Экспресс-НДЛ-кодекстерин» по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021 предназначены для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом. Калибратор «Экспресс-НДЛ-кодекстерин» по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021 предназначен для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом.

Важные и специальные указания
«Экспресс-НДЛ-кодекстерин» предназначен для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом. Реактивы «Экспресс-НДЛ-кодекстерин» по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021 предназначены для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом. Калибратор «Экспресс-НДЛ-кодекстерин» по ТУ 21.20.13-017-40341780-2021 предназначен для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым флуоресцентно-фотометрическим методом.

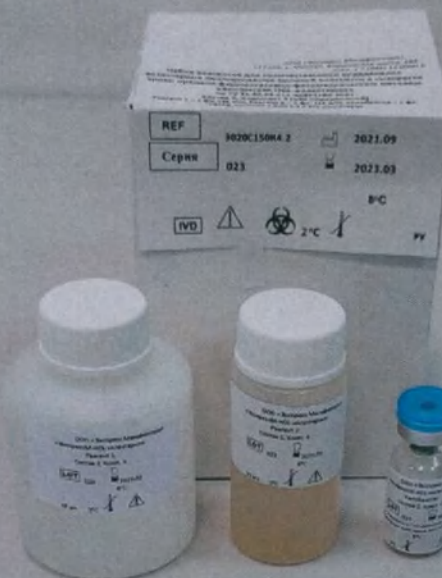

Кат. № 3020C **IVD** Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

90/180/120/150/180/200/220/250/300/390/400/600 определений*

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производители: ООО «СЕРВИС ХЕМИКАЛС»
 117025, город Москва, Ботанический проезд, дом 10А, этаж 2 пом. 302а пом. 2, 3, 3, 4.
 Место производства: 117025, город Москва, Ботанический проезд, дом 10А, этаж 2 пом. 302а пом. 2, 3, 3, 4.
 Тел.: +7 (495) 786-00-00
 e-mail: info@servis-chem.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.

Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021 предназначен для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве диагностического биомаркера угрозы повреждения сосудистой стенки и образования сосудистых бляшек и в качестве вспомогательного средства в диагностике атеросклероза и контроля за эффективностью терапии.

Функциональное назначение: вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не имеет популяционных и демографических ограничений.

Показания и противопоказания:
 Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» используется в качестве вспомогательного средства в диагностике заболеваний, вызванных нарушением липидного обмена, совместно с результатами других лабораторных исследований и клинической картиной пациента.

Противопоказаний нет.

Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.

Квалификация персонала: специально обученные специалисты (врачи клинической лабораторной диагностики, медицинские лабораторный техники (фельдшер-лаборант), врач-клинист).

Область применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание неживого изделия. Научная значимость.
 Холестерин (холестерол) – жирорастворимое вещество, относящийся к группе стероидных соединений. Холестерин содержится во всех клетках организма.

[illegible]

ООО «Экспресс-МедиаФормат»
117105, г. Москва, Вузовский проезд, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения
концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке
крови при помощи ферментативно-фотометрическим методом

«Экспресс-НДЛ-коolestерин»
по гл. 12.10.12-017-40-01-780-2021
Согласно 2. Коллигент 4 [120 (редакция)]
Регистр 1 - 1 ф. (рег. номер, Регистр 1 - 1 ф. (рег. номер) - 1 ф.
Итого, компания в гл. 12 и 117105





Кат. № 3020С [IVD] Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности и апопротеин В в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-М-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

50/100/130/160/180/200/220/250/300/350/400/450/500 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 ООО «Цирми» (ИНН 50-07-001779)
 17001, город Волгоград, Волгоградская область, адрес: 100 м, этаж: 1, комната: 1, 1.1.1.1.
 Местонахождение: 17001, город Волгоград, Волгоградская область, адрес: 100 м, этаж: 1, комната: 1, 1.1.1.1.
 Тел.: +7 (800) 400-00-00
 e-mail: info@cirmi.ru

СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ
 - Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-М-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.
 - Назначение изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-М-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021 предназначен для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в образцах сыворотки и плазмы крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве диагностического биомаркера угрозы повреждения сосудистой стенки и образования атеросклеротических бляшек и в качестве вспомогательного средства в диагностике атеросклероза и контроля за эффективностью терапии.
 - Функциональные назначения: вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не имеет популяционных и демографических ограничений.
 - Показания и противопоказания: Набор реагентов «Экспресс-М-HDL-холестерин» используется в качестве вспомогательного средства в диагностике заболеваний, вызванных нарушением липидного обмена, совместно с результатами других лабораторных исследований в клинической картине пациента.
 - Противопоказаний нет.
 - Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
 - Квалификация персонала: специально обученные специалисты (врачи клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист).
 - Область применения: Область применения изделия - in vitro диагностика.
 - Описание изделия: Описание изделия - Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-М-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.
 - Описание изделия: Описание изделия - Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-М-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.

ООО «Экспресс-МедиаФарм»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А,
тел. +7 (495) 19 0000 5

**Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеиновой высокой плотности в сыворотке крови прямым
ферментативно-фотометрическим методом**
«Экспресс-M-HDL-холестерин»
по ТУ 21.20.23-017-40341790-2021
Состав: 2. Компонент 5 (180 порций/анализ)
Реактив 1 – 1 фла. (54 мл), Реактив 2 – 1 фла. (18 мл), калибратор – 1 фла.
0,84 мг, содержание в 0,04 Л, 2 и 8°C, инструкция



Кат. № 3020С **IVD** Только для **in vitro** диагностики
Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеиновой высокой плотности в сыворотке крови прямым
ферментативно-фотометрическим методом
«Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341790-2021
500 180 130 150 180 200 220 250 300 390 480 600 900 порций/анализ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» предназначен для определения содержания холестерина липопротеиновой высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке крови методом ферментативного окисления с использованием хромогена.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» сертифицирован в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 13485:2017.

УПАКОВКА И СОДЕРЖИМОЕ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» состоит из:
1. Реактива 1 (54 мл) – 1 фла.
2. Реактива 2 (18 мл) – 1 фла.
3. Калибратора (0,84 мг) – 1 фла.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» хранить при температуре от +2°C до +8°C.

СРОКИ ГОДАШНОСТИ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» имеет срок годности 12 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» не использовать после истечения срока годности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» использовать в соответствии с инструкцией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» использовать для определения содержания холестерина ЛПВП в сыворотке крови.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» использовать для определения содержания холестерина ЛПВП в сыворотке крови.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» использовать для определения содержания холестерина ЛПВП в сыворотке крови.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» использовать для определения содержания холестерина ЛПВП в сыворотке крови.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» использовать для определения содержания холестерина ЛПВП в сыворотке крови.

[illegible]

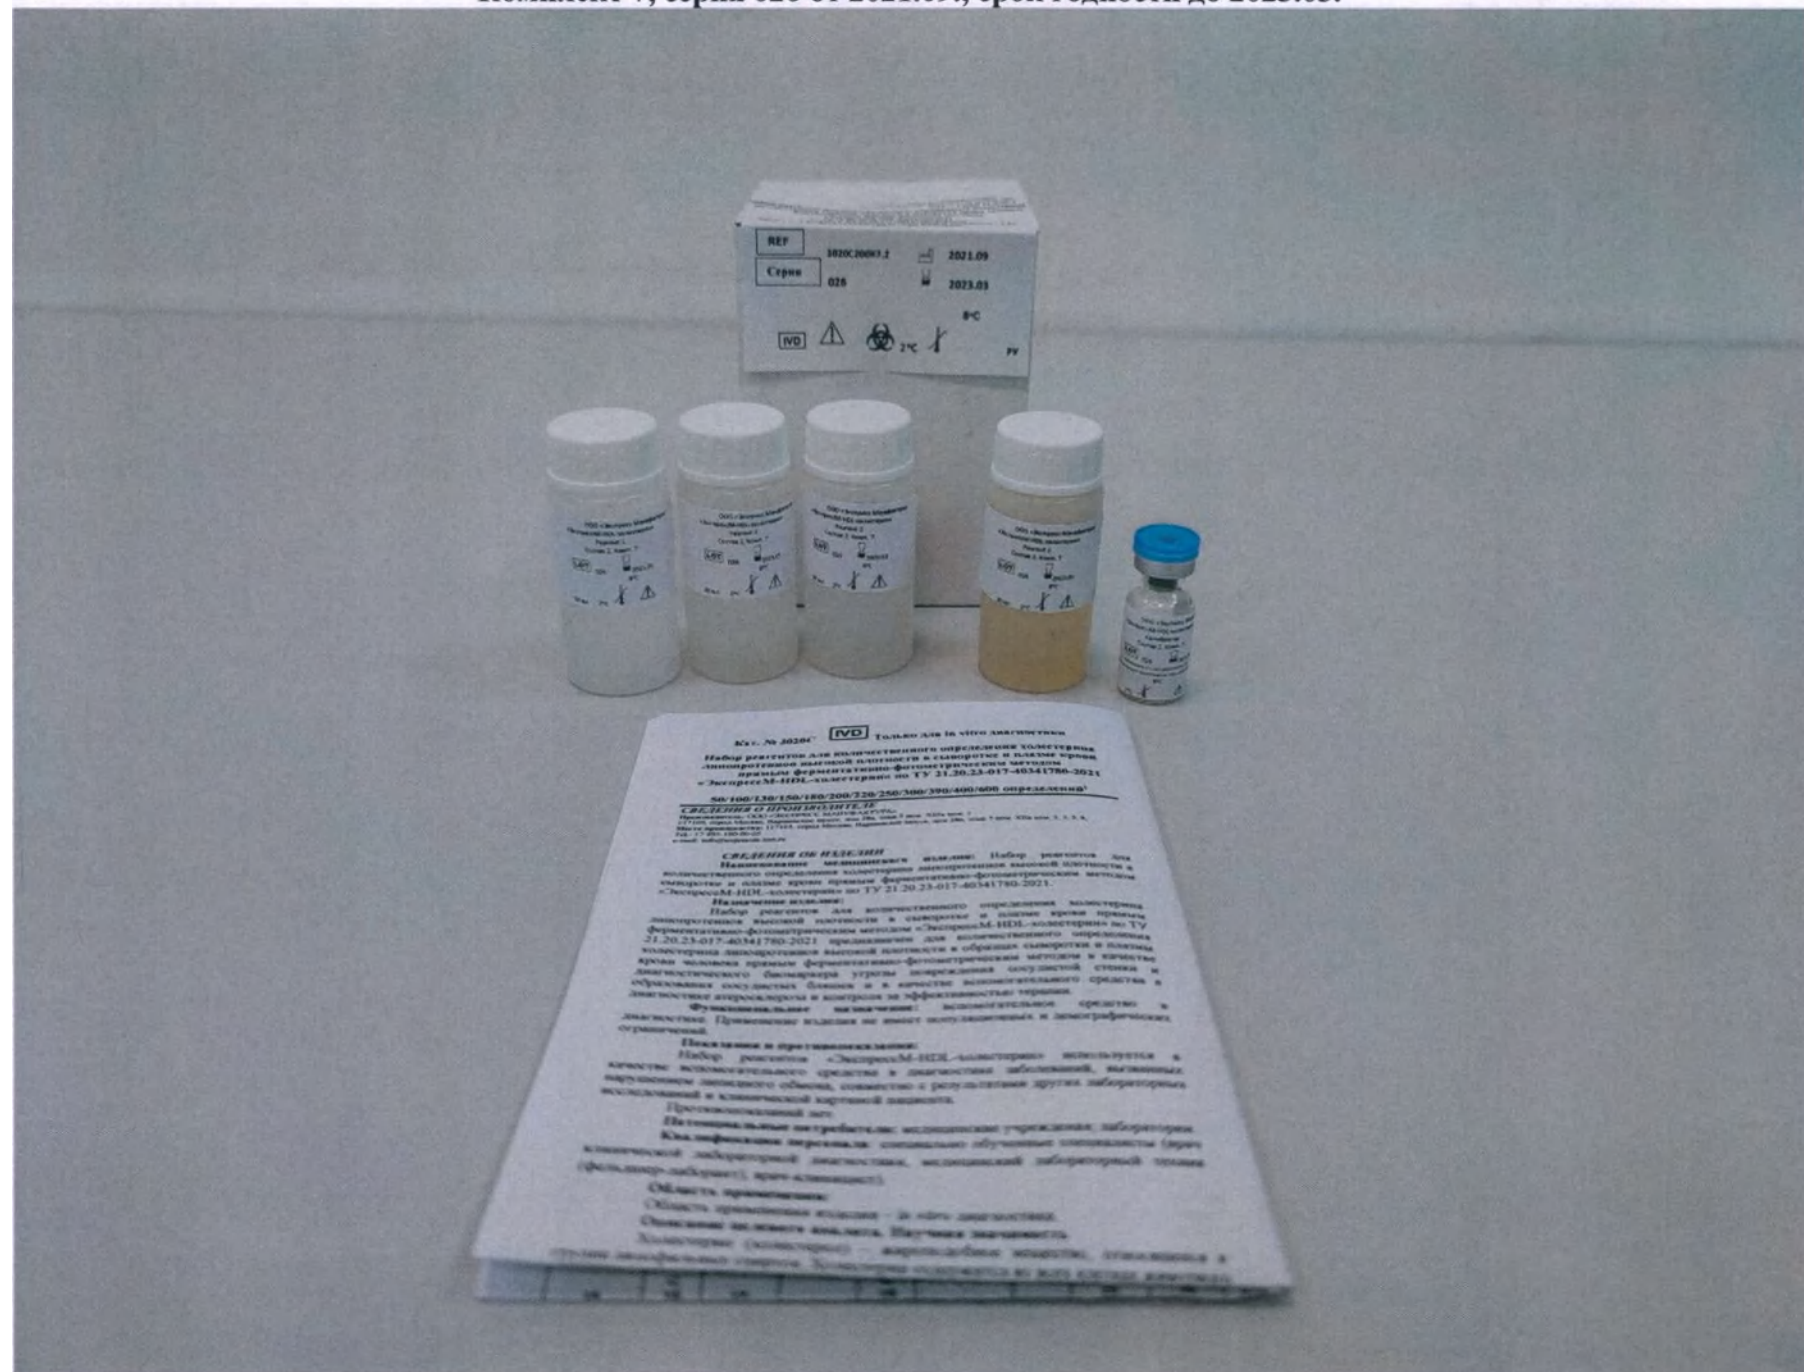

ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым
ферментативно-фотометрическим методом
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин»
по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021
Состав 2, Комплект 7 (200 определений)
Реагент 1 – 3 фла. (по 20 мл), Реагент 2 – 1 фла. (20 мл), калибратор – 1 фла.
ИВЛА, упаковка с BPR 1,2 и BFC-экспресс



Ккт. № 3020С IVD Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови
прямым ферментативно-фотометрическим методом
«ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

50/100/150/180/200/250/300/390/400/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Продукция: ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, этаж 1, пом. 1
Место производства: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, этаж 1, пом. 1, 1, 1, 1, 1, 1
Тел: +7 (495) 19 00 00 5
e-mail: info@expm.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИ
Назначение: количественное определение холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.

Назначение: измерение:
Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021 предназначен для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве диагностического биомаркера уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека в качестве диагностического биомаркера уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека в качестве диагностического биомаркера уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека.

Функциональное назначение: количественное определение холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека в качестве диагностического биомаркера уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека.

Примечание: информация не имеет отношения к диагностическим результатам.


Подающие и приготавливаемые:
Набор реагентов «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» используется в качестве вспомогательного средства в лабораторных условиях, предназначенных для диагностики заболеваний, связанных с нарушением липидного обмена, включая гиперлипидемию, гиперхолестеринемию и семейную гиперлипидемию.



Противопоказания:
Поскольку набор реагентов «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» предназначен для использования в лабораторных условиях, противопоказано его использование в домашних условиях.


Классификация: продукция предназначена для использования в лабораторных условиях, предназначенных для диагностики заболеваний, связанных с нарушением липидного обмена, включая гиперлипидемию, гиперхолестеринемию и семейную гиперлипидемию.

Область применения:
Область применения набора реагентов «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» – диагностика заболеваний, связанных с нарушением липидного обмена, включая гиперлипидемию, гиперхолестеринемию и семейную гиперлипидемию.

Описание: набор реагентов «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» – набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека в качестве диагностического биомаркера уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека.

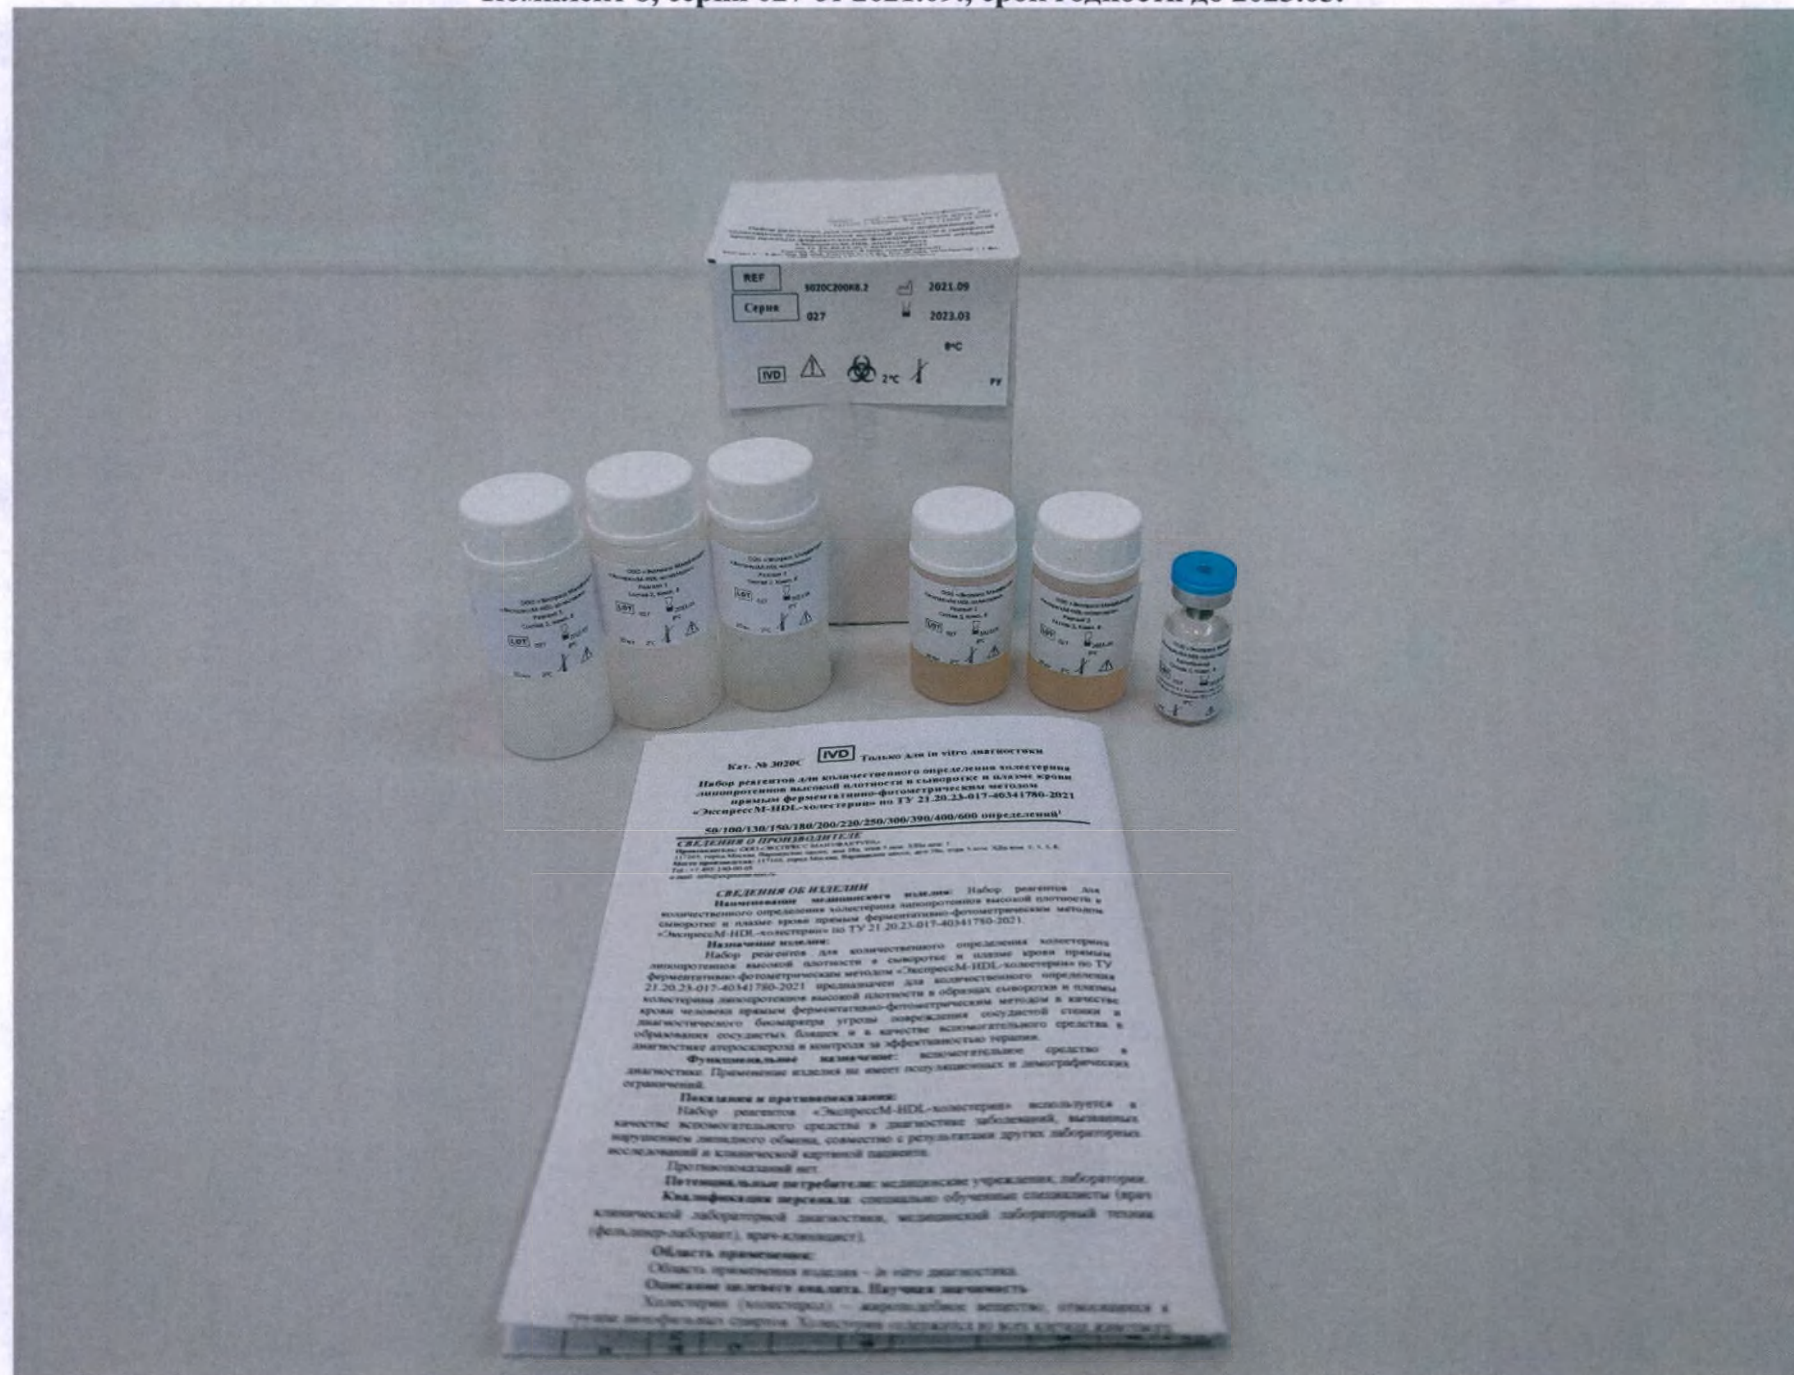

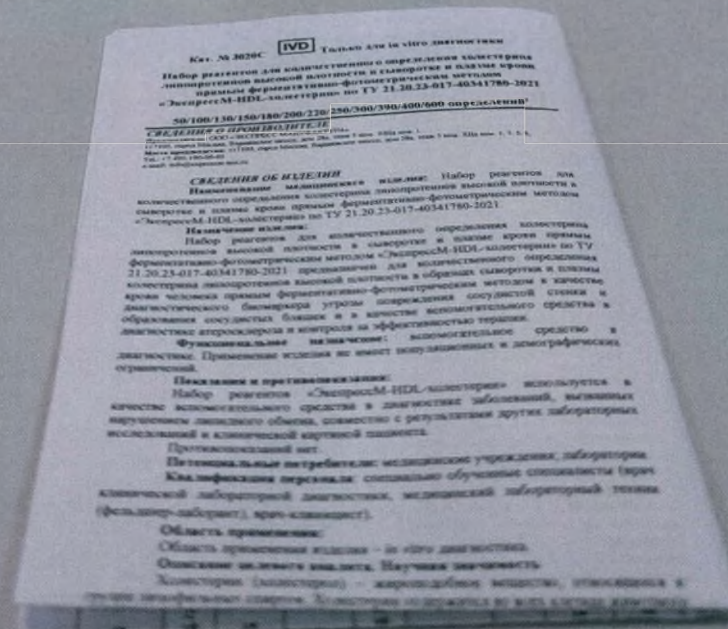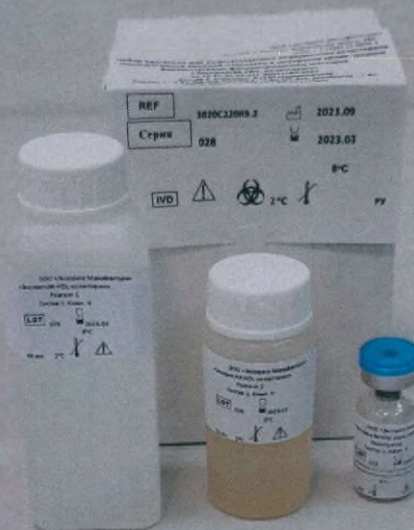

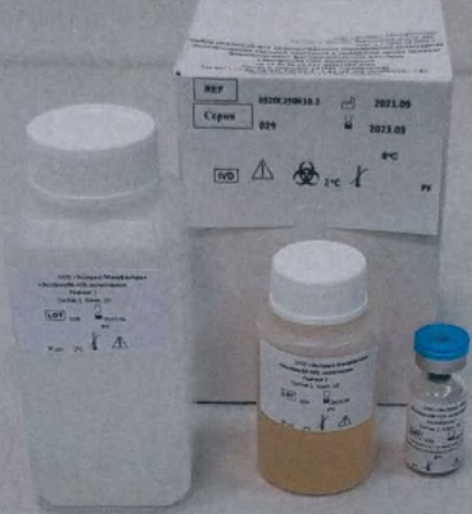

Кат. № 3020350616.2 **IVD** Голубое для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеиновой фракции высокой плотности и плазмы крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-НДЛ-холестерин» по ТУ 21.30.33-017-40341780-2021

40/100/130/150/180/200/220/250/300/360/480/600 определений*


СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЦИРМИ» (ИНН 50-07-00174, ОГРН 1155007000000)
 171003, город Самара, Самарская область, адрес: дом 10а, этаж 1 этаж, 100 кв.м. 1, 1, 3, 5.
 Место производства: 171003, город Самара, Самарская область, адрес: дом 10а, этаж 1 этаж, 100 кв.м. 1, 1, 3, 5.
 Тел.: +7 800 100-40-40
 E-mail: info@cirmi.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеиновой фракции высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-НДЛ-холестерин» по ТУ 21.30.33-017-40341780-2021.
 Наименование изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеиновой фракции высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-НДЛ-холестерин» по ТУ 21.30.33-017-40341780-2021.
 Назначение изделия: Предназначен для количественного определения холестерина липопротеиновой фракции высокой плотности в образцах сыворотки и плазмы крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве диагностического, биомаркера угрозы атеросклероза, последней стадии и образования атеросклеротической бляшки и в качестве вспомогательного средства в диагностике атеросклероза и контроля за эффективностью терапии.
 Функциональное назначение: вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не имеет географических и демографических ограничений.
 Показания и противопоказания: Набор реагентов «ЭкспрессМ-НДЛ-холестерин» используется в качестве вспомогательного средства в диагностике заболеваний, вызванных нарушением липидного обмена, совместно с результатами других лабораторных исследований и клинической картиной пациента.
 Препаратовый лет: Нет.
 Потребительские требования: медицинским учреждениям, лабораториям.
 Классификация персонала: специально обученные специалисты (врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист).
 Область применения: Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание целевого анализа: Научная значимость: Холестерин (холестерол) – жирорастворимое вещество, относящееся к группе липофильных спиртов. Холестерин содержится во всех клетках животного


Набор реагентов для количественного определения активности
липопротеиновой фракции в сыворотке крови методом
«Экспресс-ИД-колестерин»
Состав 2, Компонент 10 [250 порций/анализ]
но ТУ 11.20.23-017-4041780-2021
«Экспресс-ИД-колестерин»
Фармацевтическая компания «ИД»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.88
тел. +7 (495) 19 0000 5
факс +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения активности
липопротеиновой фракции в сыворотке крови методом
«Экспресс-ИД-колестерин»
Состав 2, Компонент 10 [250 порций/анализ]
но ТУ 11.20.23-017-4041780-2021
«Экспресс-ИД-колестерин»
Фармацевтическая компания «ИД»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.88
тел. +7 (495) 19 0000 5
факс +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения активности
липопротеиновой фракции в сыворотке крови методом
«Экспресс-ИД-колестерин»
Состав 2, Компонент 10 [250 порций/анализ]
но ТУ 11.20.23-017-4041780-2021
«Экспресс-ИД-колестерин»
Фармацевтическая компания «ИД»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.88
тел. +7 (495) 19 0000 5
факс +7 (495) 19 0000 5

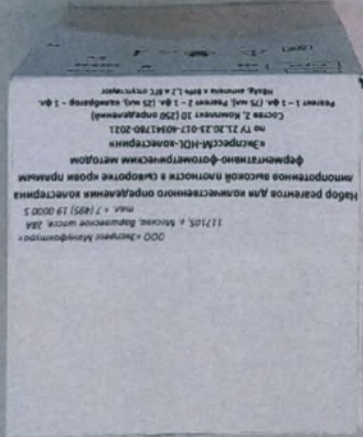

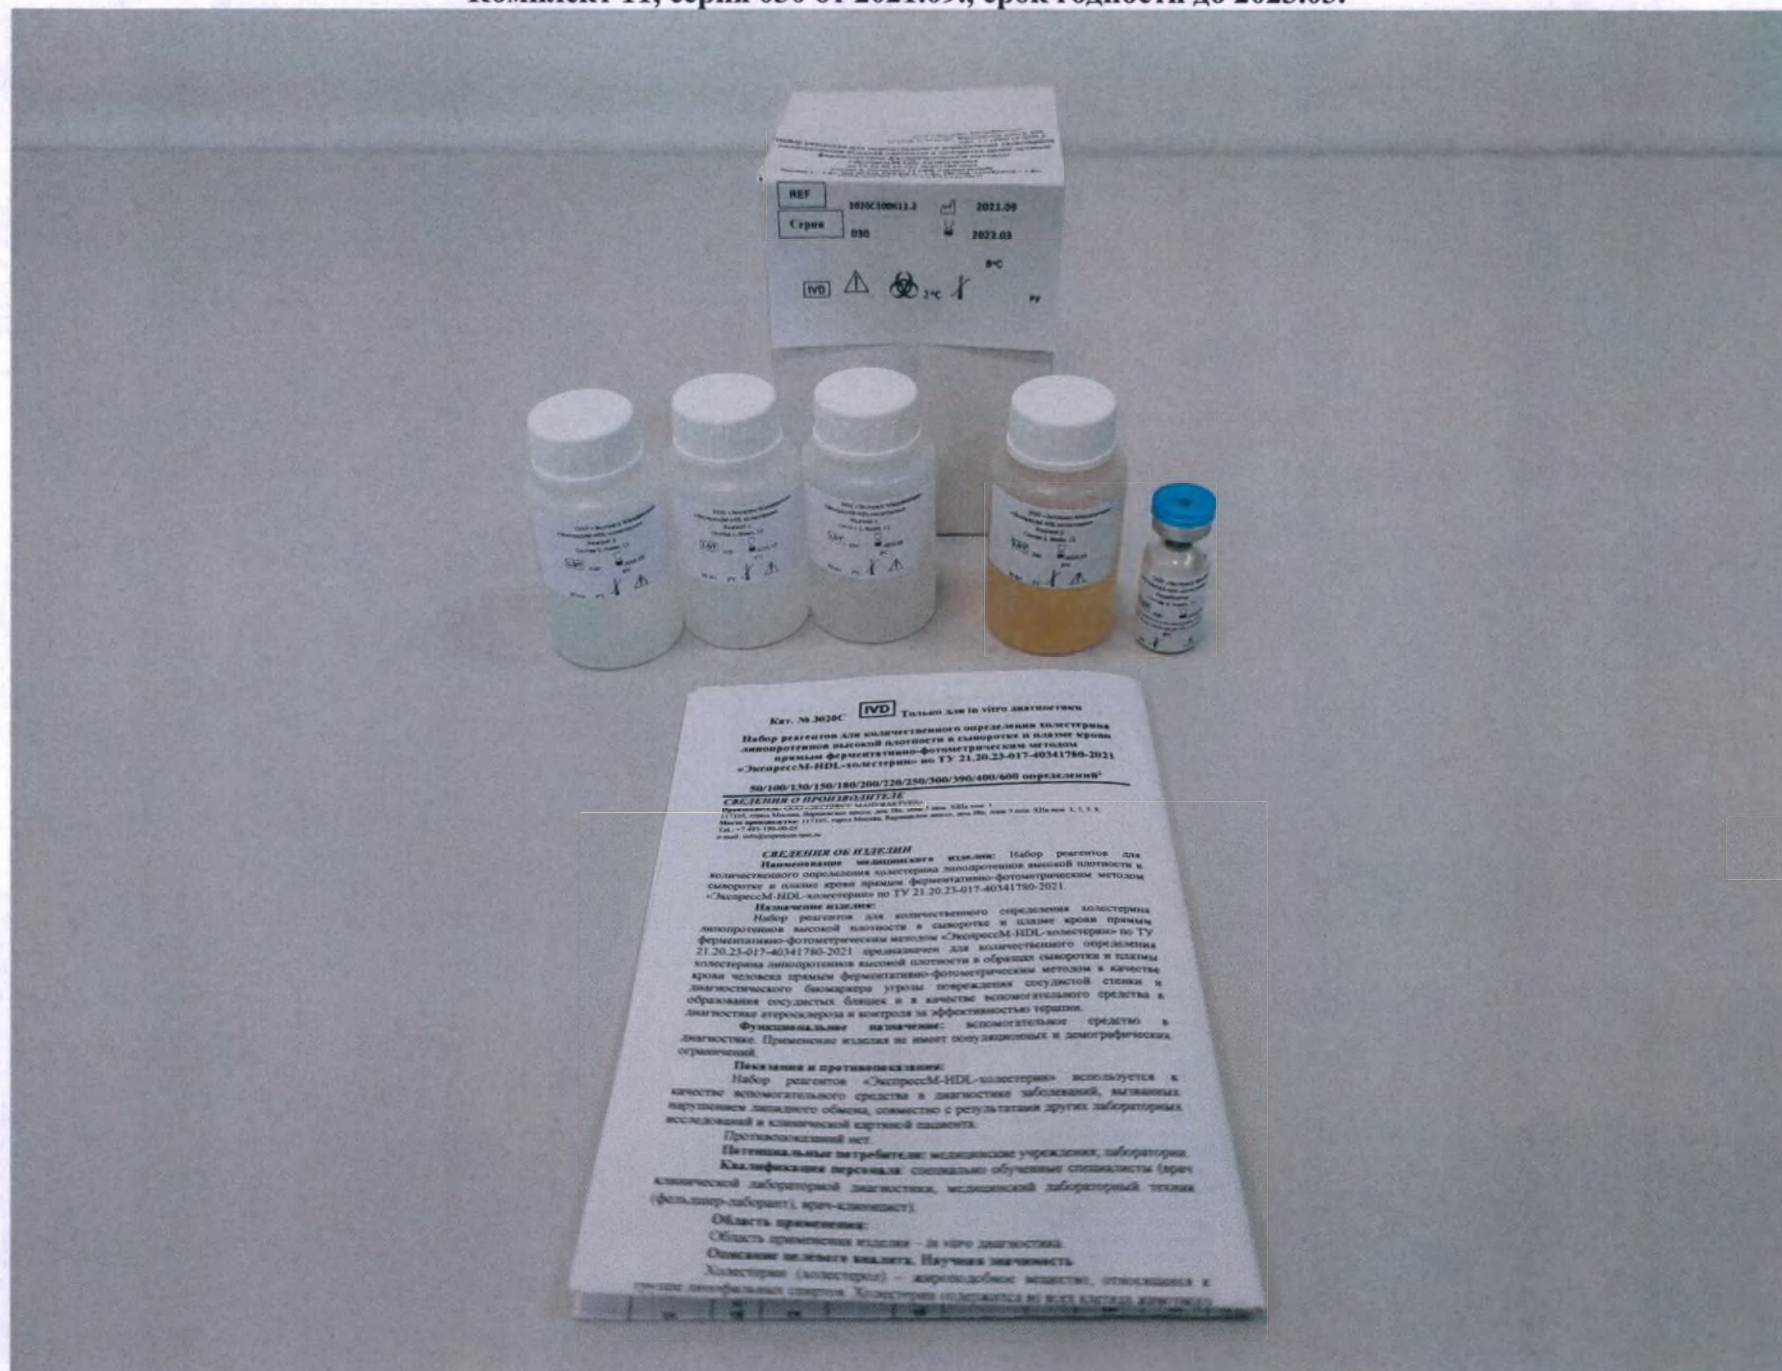

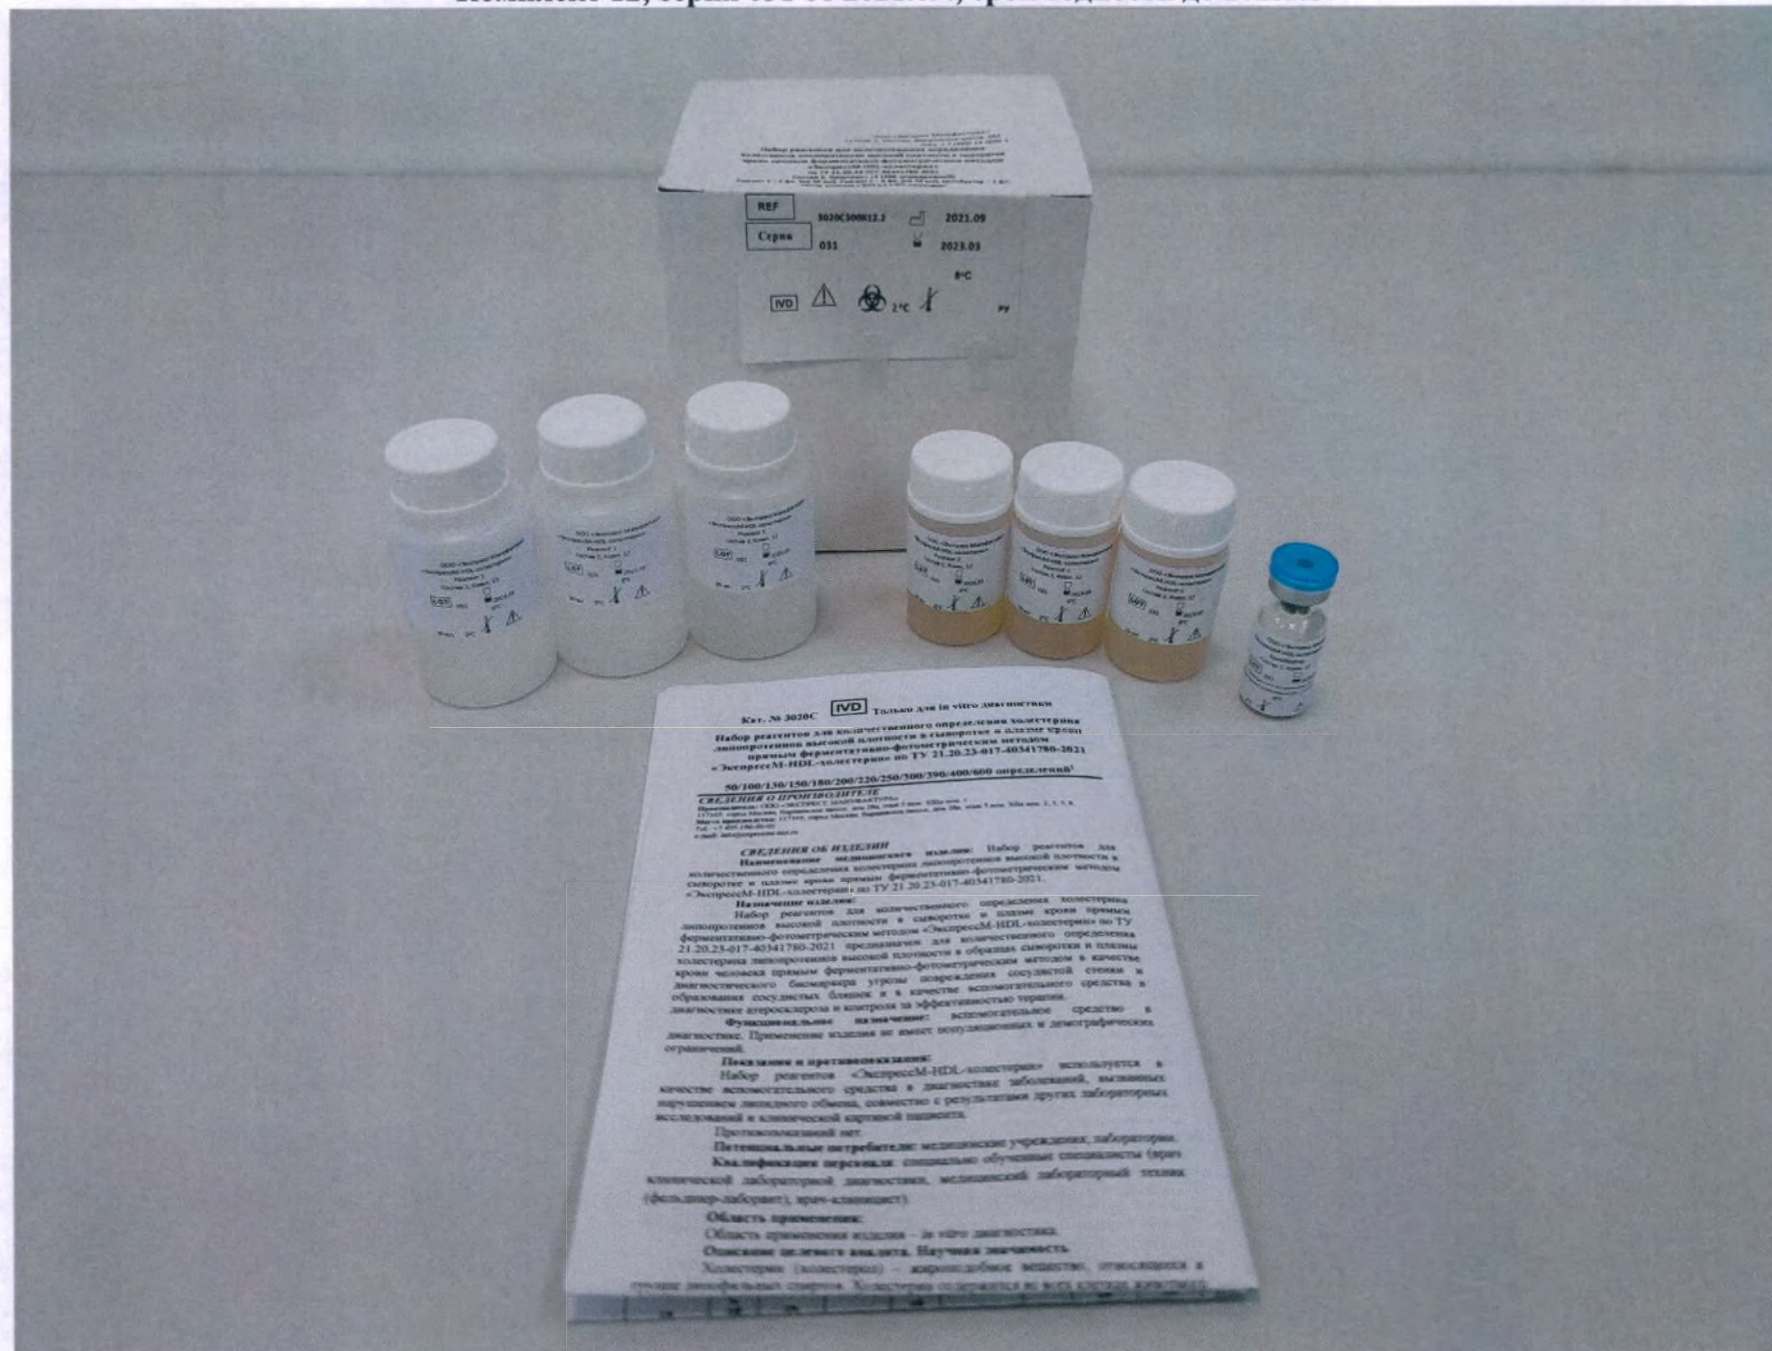

[illegible]

KEY: No 3020C  TUNISI AIR IN VITO JOURNALISM

«Эксперт» МНДЛ «Холдинг» по ТП 21.26.23.017-4031780-2021
прямых фирменных фотоаппаратов не имеет
информацию о наличии в складов и в наличии
информацию о наличии в складов и в наличии

© 2001 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112

СЕРТИФИКАТ НА РЕЗУЛТАТ
Намеренията на кандидатът за участие в конкурса са
напълно съвместими с интересите на обществото и
на държавата. Кандидатът е одобрен за участие в конкурса.

[illegible]


1. **Вопросы к семинару:**


1. Какие задачи ставит перед собой наука?
2. Какие задачи ставит перед собой философия?
3. Какие задачи ставит перед собой искусство?
4. Какие задачи ставит перед собой религия?
5. Какие задачи ставит перед собой политика?
6. Какие задачи ставит перед собой экономика?
7. Какие задачи ставит перед собой социология?
8. Какие задачи ставит перед собой психология?
9. Какие задачи ставит перед собой педагогика?
10. Какие задачи ставит перед собой медицина?
11. Какие задачи ставит перед собой право?
12. Какие задачи ставит перед собой литература?
13. Какие задачи ставит перед собой музыка?
14. Какие задачи ставит перед собой живопись?
15. Какие задачи ставит перед собой скульптура?
16. Какие задачи ставит перед собой архитектура?
17. Какие задачи ставит перед собой дизайн?
18. Какие задачи ставит перед собой мода?
19. Какие задачи ставит перед собой спорт?
20. Какие задачи ставит перед собой туризм?
21. Какие задачи ставит перед собой образование?
22. Какие задачи ставит перед собой наука?

2. **Вопросы к семинару:**

1. Какие задачи ставит перед собой наука?
2. Какие задачи ставит перед собой философия?
3. Какие задачи ставит перед собой искусство?
4. Какие задачи ставит перед собой религия?
5. Какие задачи ставит перед собой политика?
6. Какие задачи ставит перед собой экономика?
7. Какие задачи ставит перед собой социология?
8. Какие задачи ставит перед собой психология?
9. Какие задачи ставит перед собой педагогика?
10. Какие задачи ставит перед собой медицина?
11. Какие задачи ставит перед собой право?
12. Какие задачи ставит перед собой литература?
13. Какие задачи ставит перед собой музыка?
14. Какие задачи ставит перед собой живопись?
15. Какие задачи ставит перед собой скульптура?
16. Какие задачи ставит перед собой архитектура?
17. Какие задачи ставит перед собой дизайн?
18. Какие задачи ставит перед собой мода?
19. Какие задачи ставит перед собой спорт?
20. Какие задачи ставит перед собой туризм?
21. Какие задачи ставит перед собой образование?
22. Какие задачи ставит перед собой наука?

Содержание: 1. Введение. 2. Описание объекта исследования. 3. Методика исследования. 4. Результаты исследования. 5. Заключение. 6. Литература. 7. Приложение.

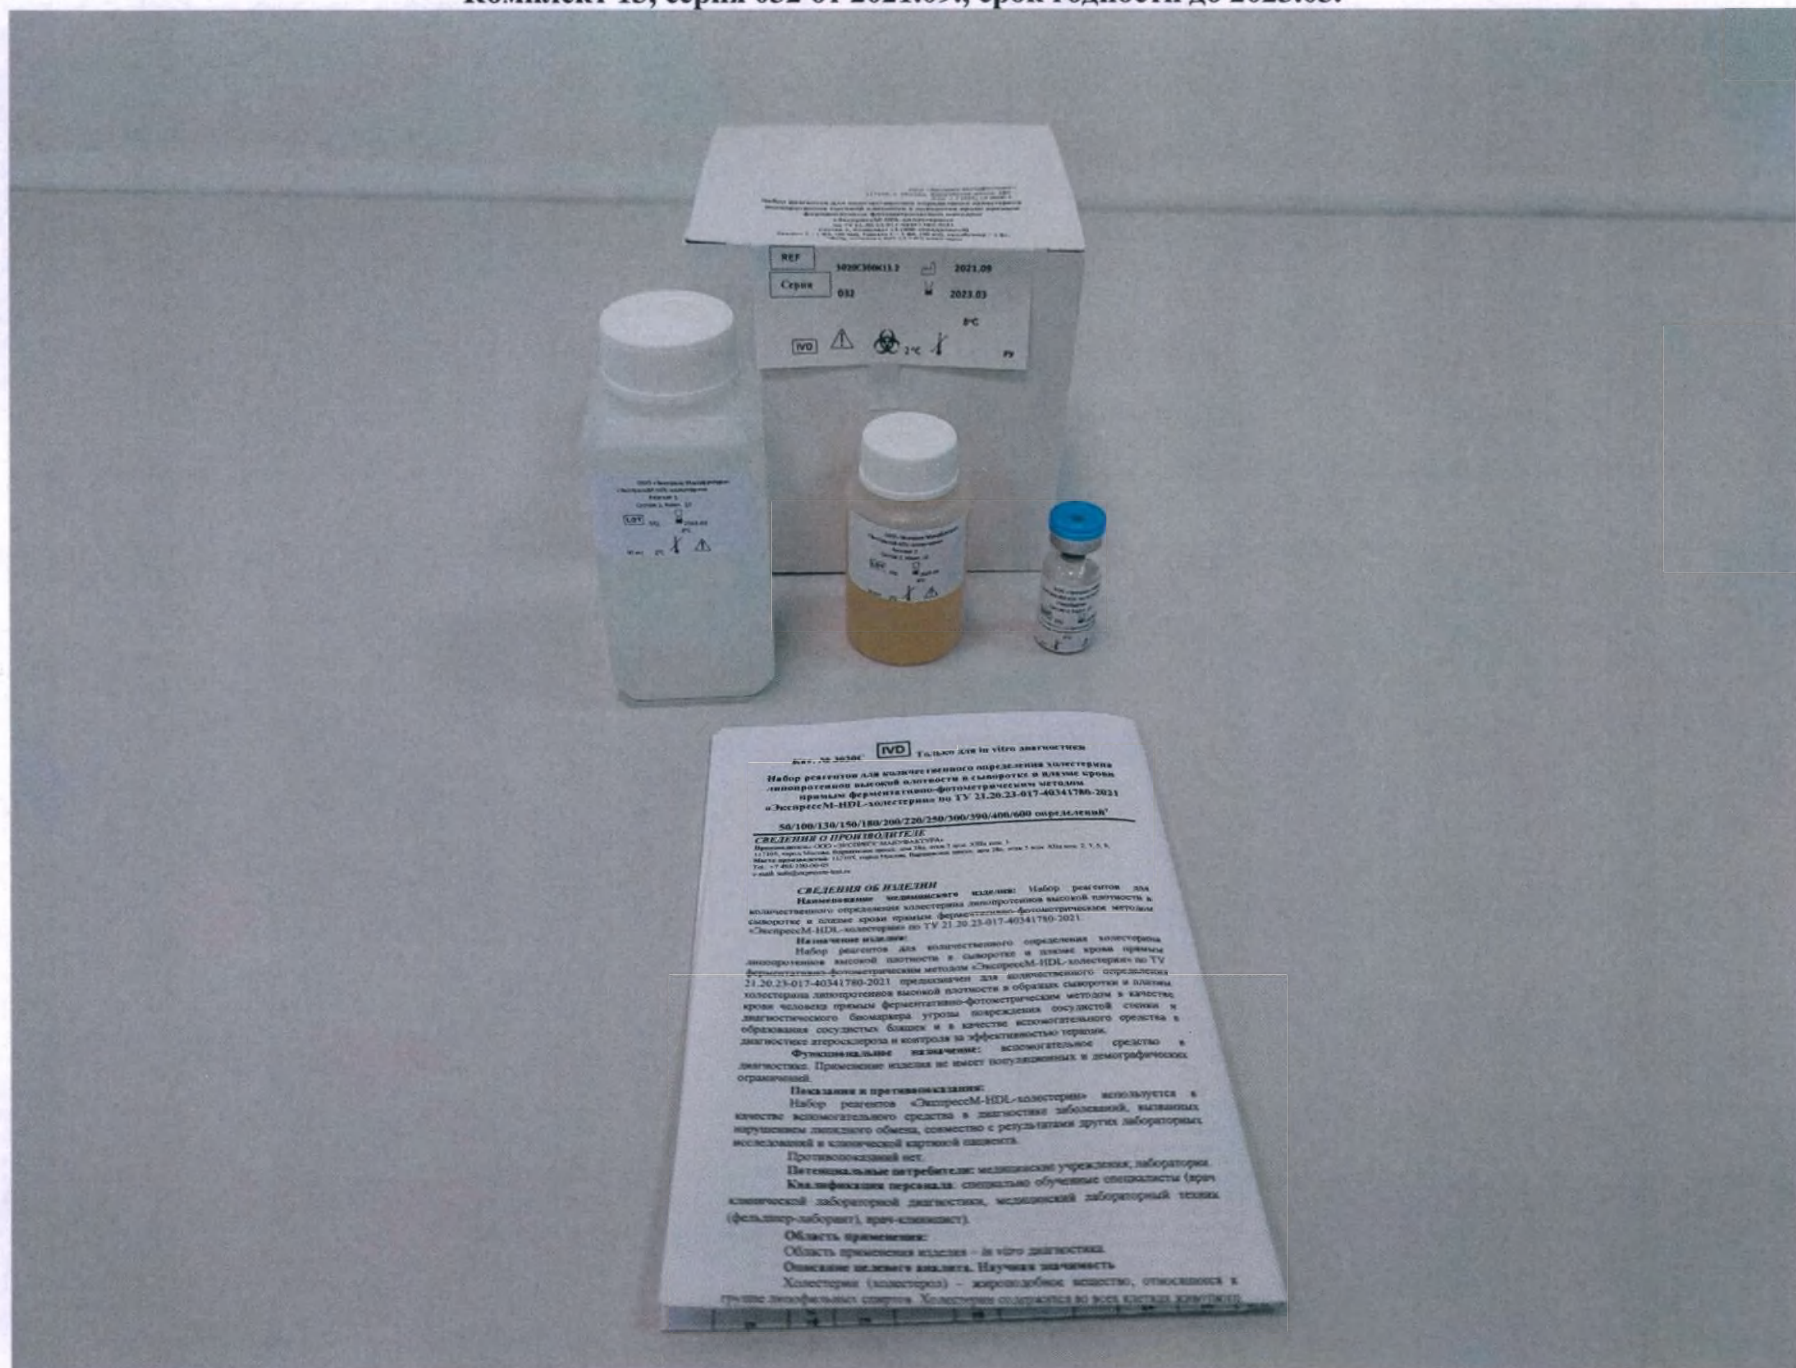

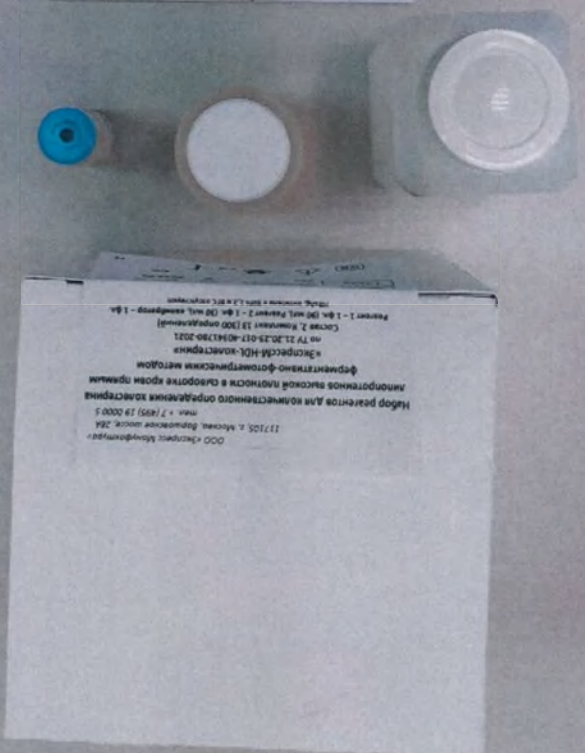



Идбор реагентов для количественного определения активности ферментов в сыворотке крови методом иммунофлуоресцентного анализа


Каждый реагент для количественного определения активности ферментов в сыворотке крови методом иммунофлуоресцентного анализа состоит из двух флаконов: флакона с реактивом и флакона с субстратом. Реактив и субстрат должны храниться в холодильнике при температуре от +2 до +8 °С. Срок годности реагентов - 12 месяцев со дня изготовления.


Идбор реагентов для количественного определения активности ферментов в сыворотке крови методом иммунофлуоресцентного анализа предназначен для использования в автоматизированной системе анализа крови Идбор-Анализатор. Система анализа крови Идбор-Анализатор предназначена для автоматизированного анализа крови на содержание ферментов в сыворотке крови.


Идбор реагентов для количественного определения активности ферментов в сыворотке крови методом иммунофлуоресцентного анализа предназначен для использования в автоматизированной системе анализа крови Идбор-Анализатор. Система анализа крови Идбор-Анализатор предназначена для автоматизированного анализа крови на содержание ферментов в сыворотке крови.

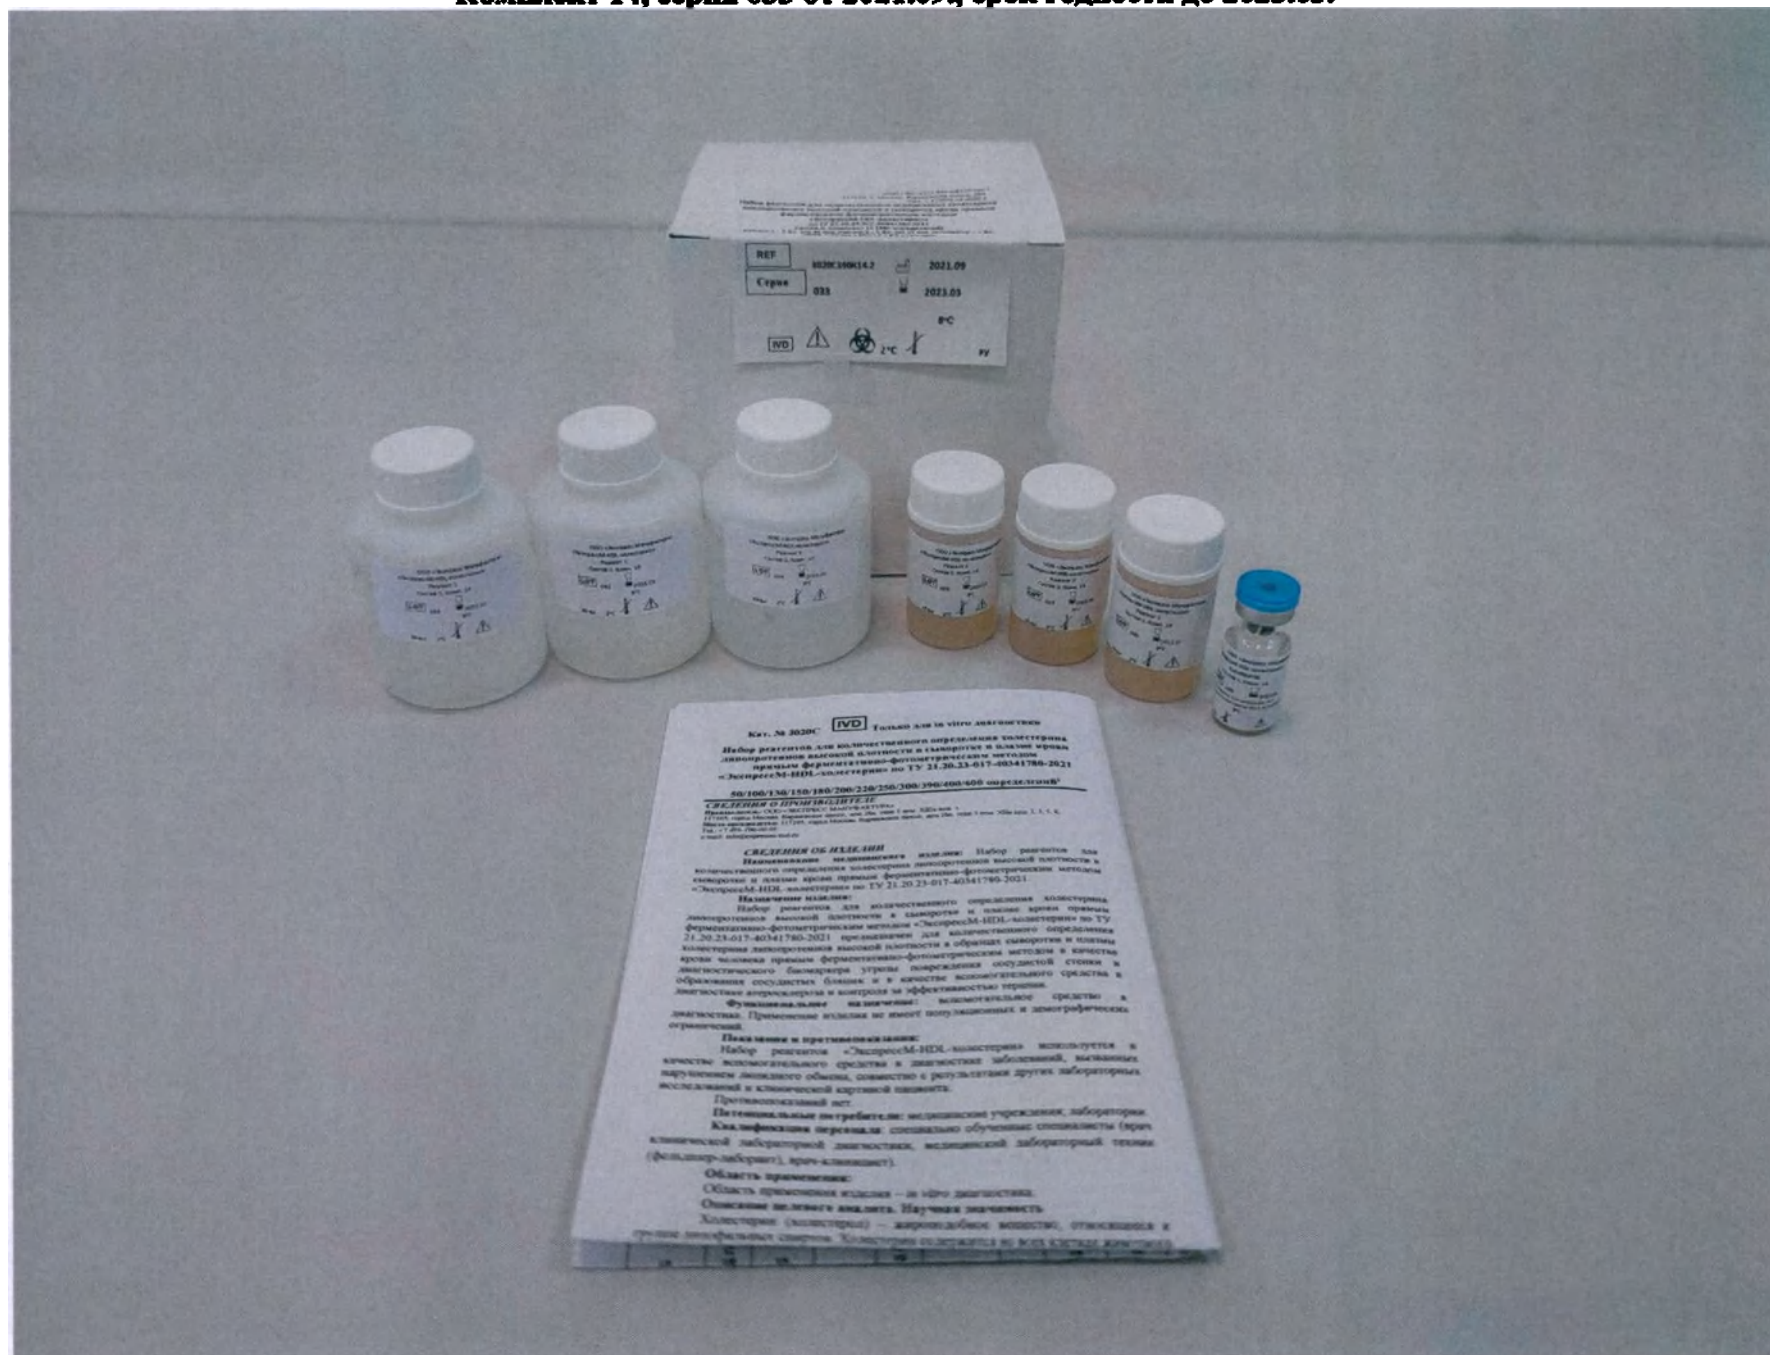

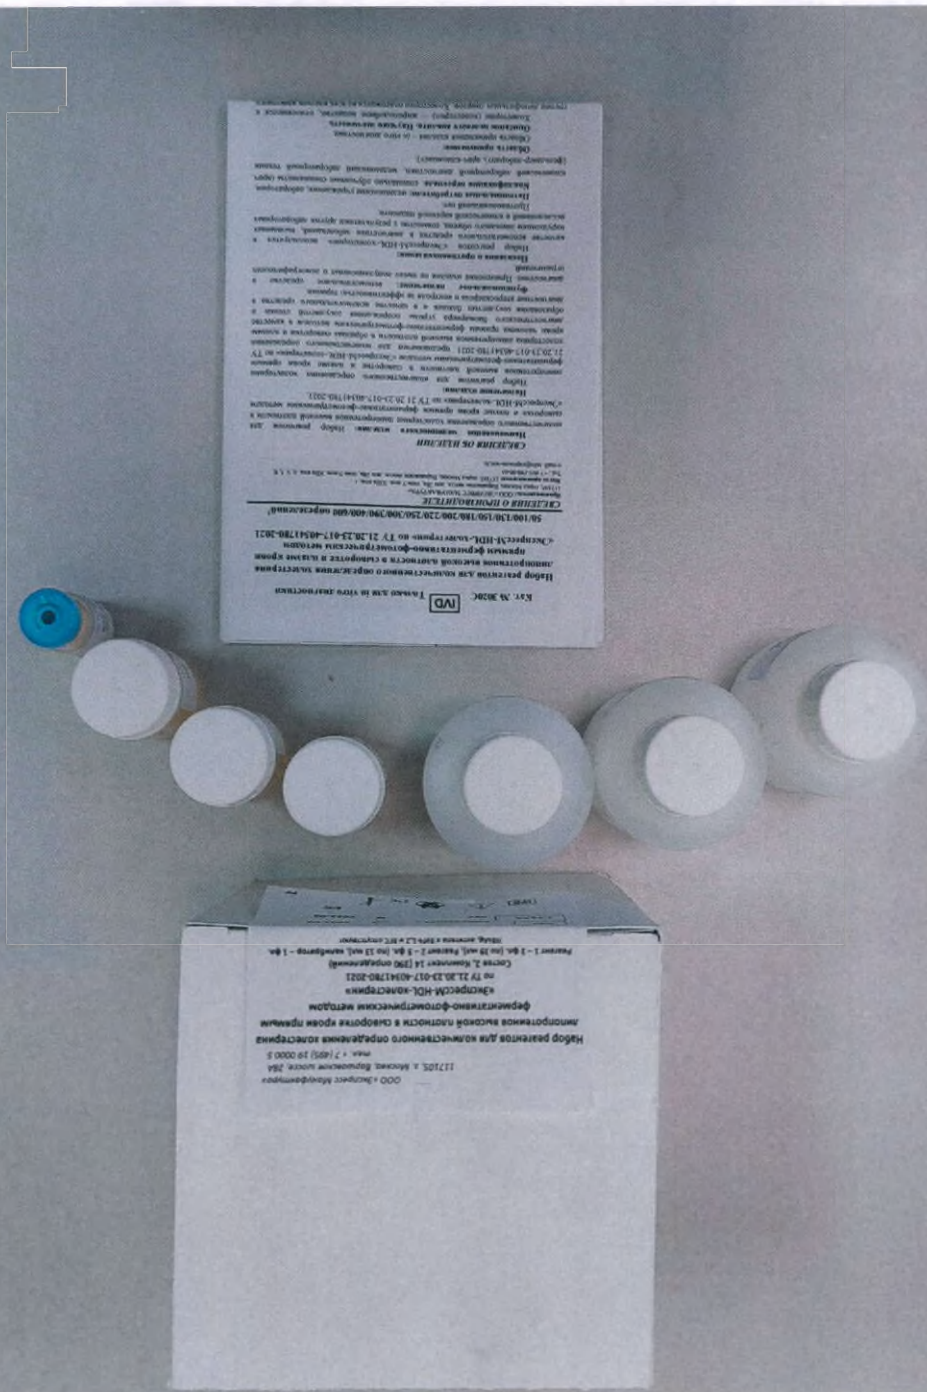

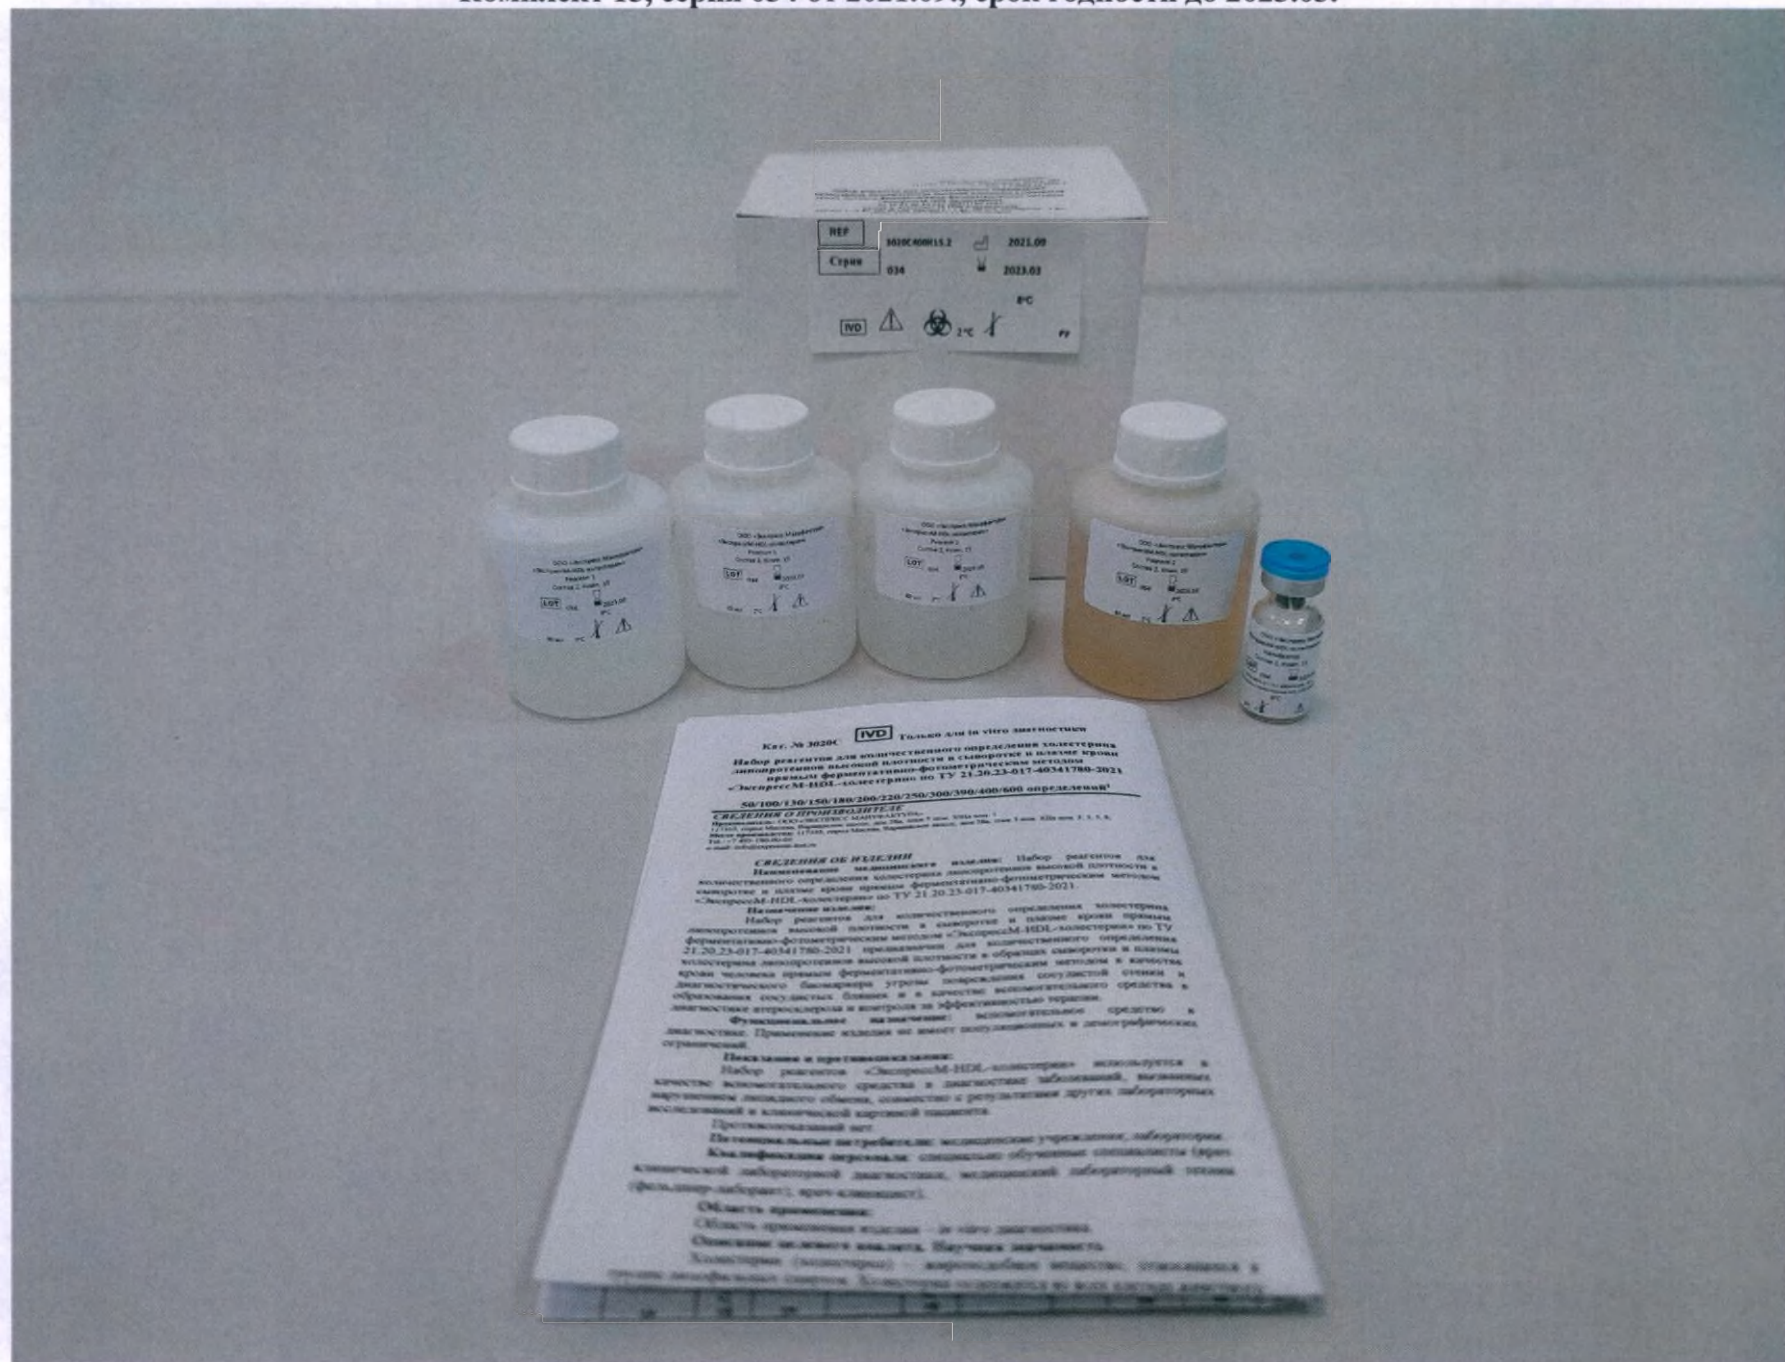

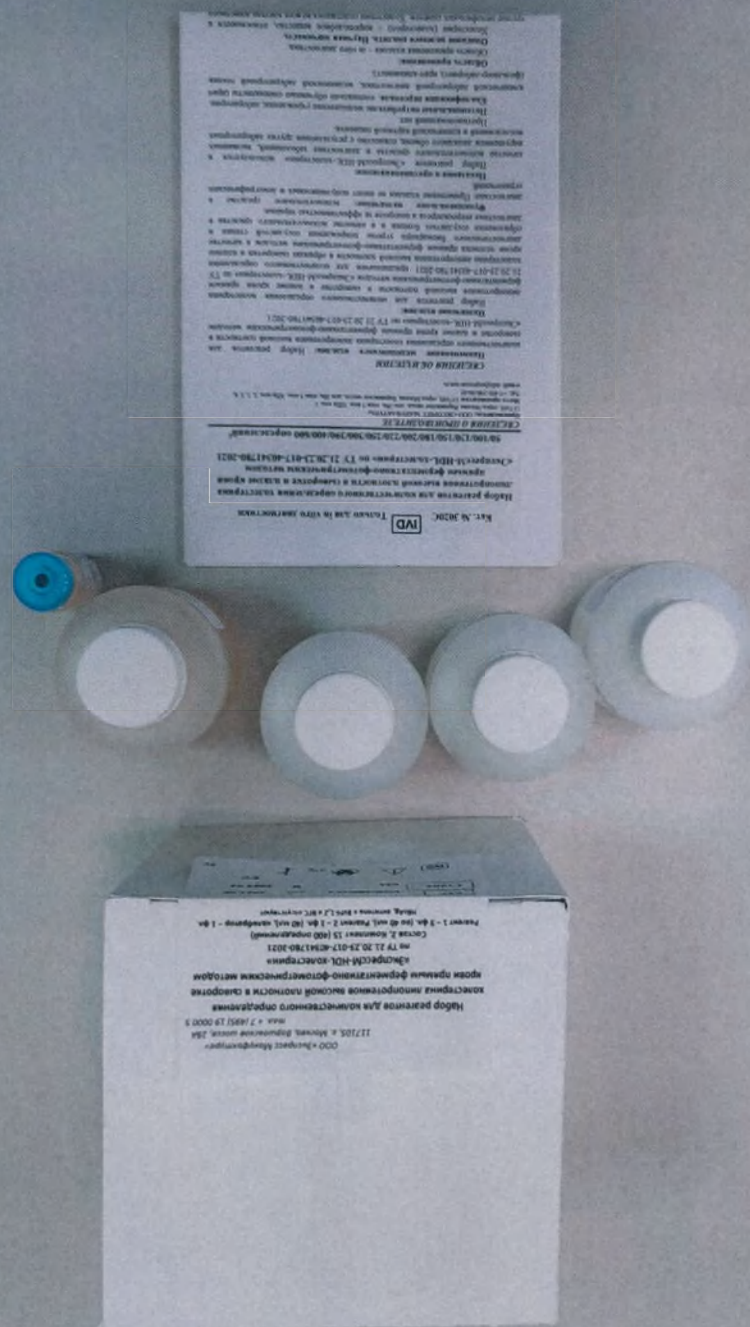

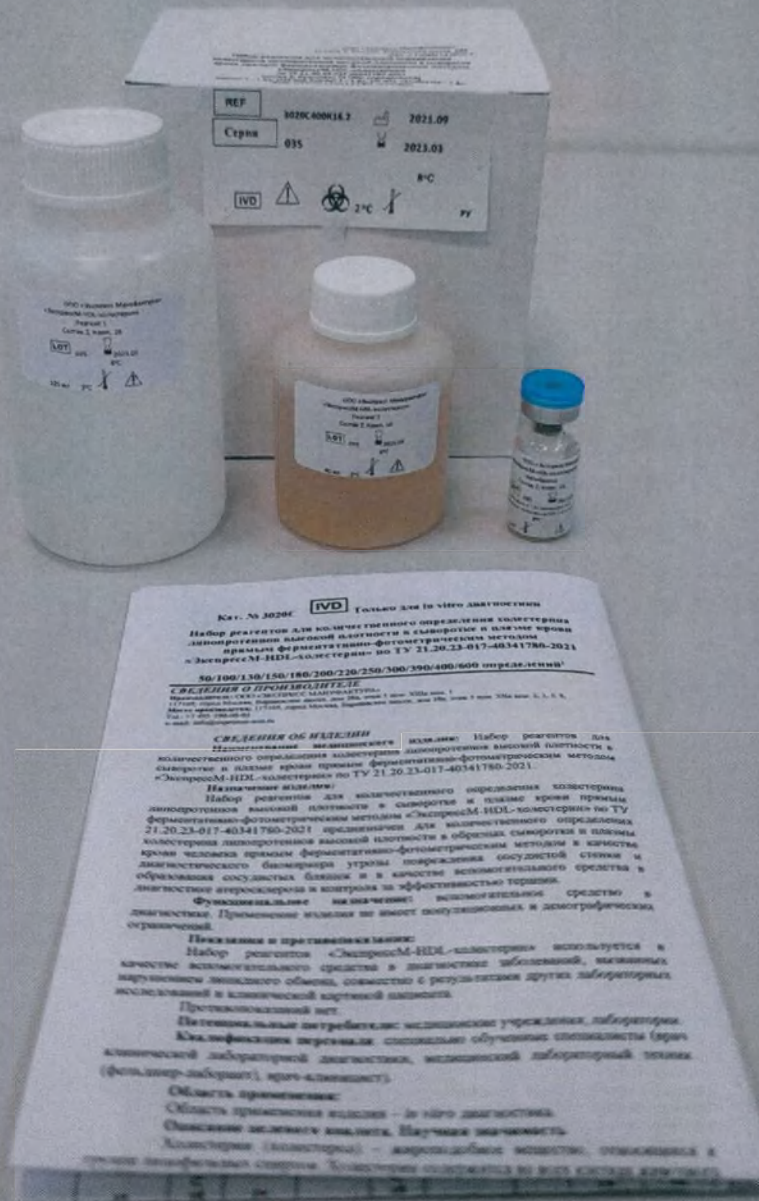

Кат. № 2020С

ИД

Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения концентрации антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) в сыворотке крови методом флуоресцентно-ферментативного анализа (ФФА).

Состав набора: 1 флакон (10 мл) реагента, 1 флакон (10 мл) субстрата, 1 флакон (10 мл) раствора калия дигидрофосфата (КДГФ), 1 флакон (10 мл) раствора калия глицерофосфата (КГФ), 1 флакон (10 мл) раствора калия эдтата (КЭДТА), 1 флакон (10 мл) раствора калия цитрата (КЦИТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия оксалата (КОКСАЛ), 1 флакон (10 мл) раствора калия ацетата (КАЦЕТА), 1 флакон (10 мл) раствора калия бисульфата (КБСУЛФАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия перманганата (КПЕРМАНГАНАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия хромата (КХРОМАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия селениата (КСЕЛЕНИАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия йодида (КИОДИД), 1 флакон (10 мл) раствора калия бромата (КБРОМАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия перхлората (КПЕРХЛОРАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия хлорида (КХЛОРИД), 1 флакон (10 мл) раствора калия нитрата (КНИТРАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия сульфата (КСУЛФАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия фосфата (КФОСФАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия ацетата (КАЦЕТА), 1 флакон (10 мл) раствора калия бисульфата (КБСУЛФАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия перманганата (КПЕРМАНГАНАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия хромата (КХРОМАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия селениата (КСЕЛЕНИАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия йодида (КИОДИД), 1 флакон (10 мл) раствора калия бромата (КБРОМАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия перхлората (КПЕРХЛОРАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия хлорида (КХЛОРИД), 1 флакон (10 мл) раствора калия нитрата (КНИТРАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия сульфата (КСУЛФАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия фосфата (КФОСФАТ).

Срок годности: 12 месяцев.

Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С.

Производитель: ООО «Зенит».

Адрес: 111100, г. Москва, Мясницкая улица, д. 38А.

Тел: +7 (495) 19 0000 5.

Сайт: www.zenit.ru.

Идентификационный номер: 2020С-017-0011790-2021.

Состав набора: 1 флакон (10 мл) реагента, 1 флакон (10 мл) субстрата, 1 флакон (10 мл) раствора калия дигидрофосфата (КДГФ), 1 флакон (10 мл) раствора калия глицерофосфата (КГФ), 1 флакон (10 мл) раствора калия эдтата (КЭДТА), 1 флакон (10 мл) раствора калия цитрата (КЦИТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия оксалата (КОКСАЛ), 1 флакон (10 мл) раствора калия ацетата (КАЦЕТА), 1 флакон (10 мл) раствора калия бисульфата (КБСУЛФАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия перманганата (КПЕРМАНГАНАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия хромата (КХРОМАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия селениата (КСЕЛЕНИАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия йодида (КИОДИД), 1 флакон (10 мл) раствора калия бромата (КБРОМАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия перхлората (КПЕРХЛОРАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия хлорида (КХЛОРИД), 1 флакон (10 мл) раствора калия нитрата (КНИТРАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия сульфата (КСУЛФАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия фосфата (КФОСФАТ).

Срок годности: 12 месяцев.

Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С.

Производитель: ООО «Зенит».

Адрес: 111100, г. Москва, Мясницкая улица, д. 38А.

Тел: +7 (495) 19 0000 5.

Сайт: www.zenit.ru.

Идентификационный номер: 2020С-017-0011790-2021.



Набор реагентов для количественного определения концентрации антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) в сыворотке крови методом флуоресцентно-ферментативного анализа (ФФА).

Состав набора: 1 флакон (10 мл) реагента, 1 флакон (10 мл) субстрата, 1 флакон (10 мл) раствора калия дигидрофосфата (КДГФ), 1 флакон (10 мл) раствора калия глицерофосфата (КГФ), 1 флакон (10 мл) раствора калия эдтата (КЭДТА), 1 флакон (10 мл) раствора калия цитрата (КЦИТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия оксалата (КОКСАЛ), 1 флакон (10 мл) раствора калия ацетата (КАЦЕТА), 1 флакон (10 мл) раствора калия бисульфата (КБСУЛФАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия перманганата (КПЕРМАНГАНАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия хромата (КХРОМАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия селениата (КСЕЛЕНИАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия йодида (КИОДИД), 1 флакон (10 мл) раствора калия бромата (КБРОМАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия перхлората (КПЕРХЛОРАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия хлорида (КХЛОРИД), 1 флакон (10 мл) раствора калия нитрата (КНИТРАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия сульфата (КСУЛФАТ), 1 флакон (10 мл) раствора калия фосфата (КФОСФАТ).

Срок годности: 12 месяцев.

Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С.


Производитель: ООО «Зенит».



Адрес: 111100, г. Москва, Мясницкая улица, д. 38А.



Тел: +7 (495) 19 0000 5.


Сайт: www.zenit.ru.

Идентификационный номер: 2020С-017-0011790-2021.

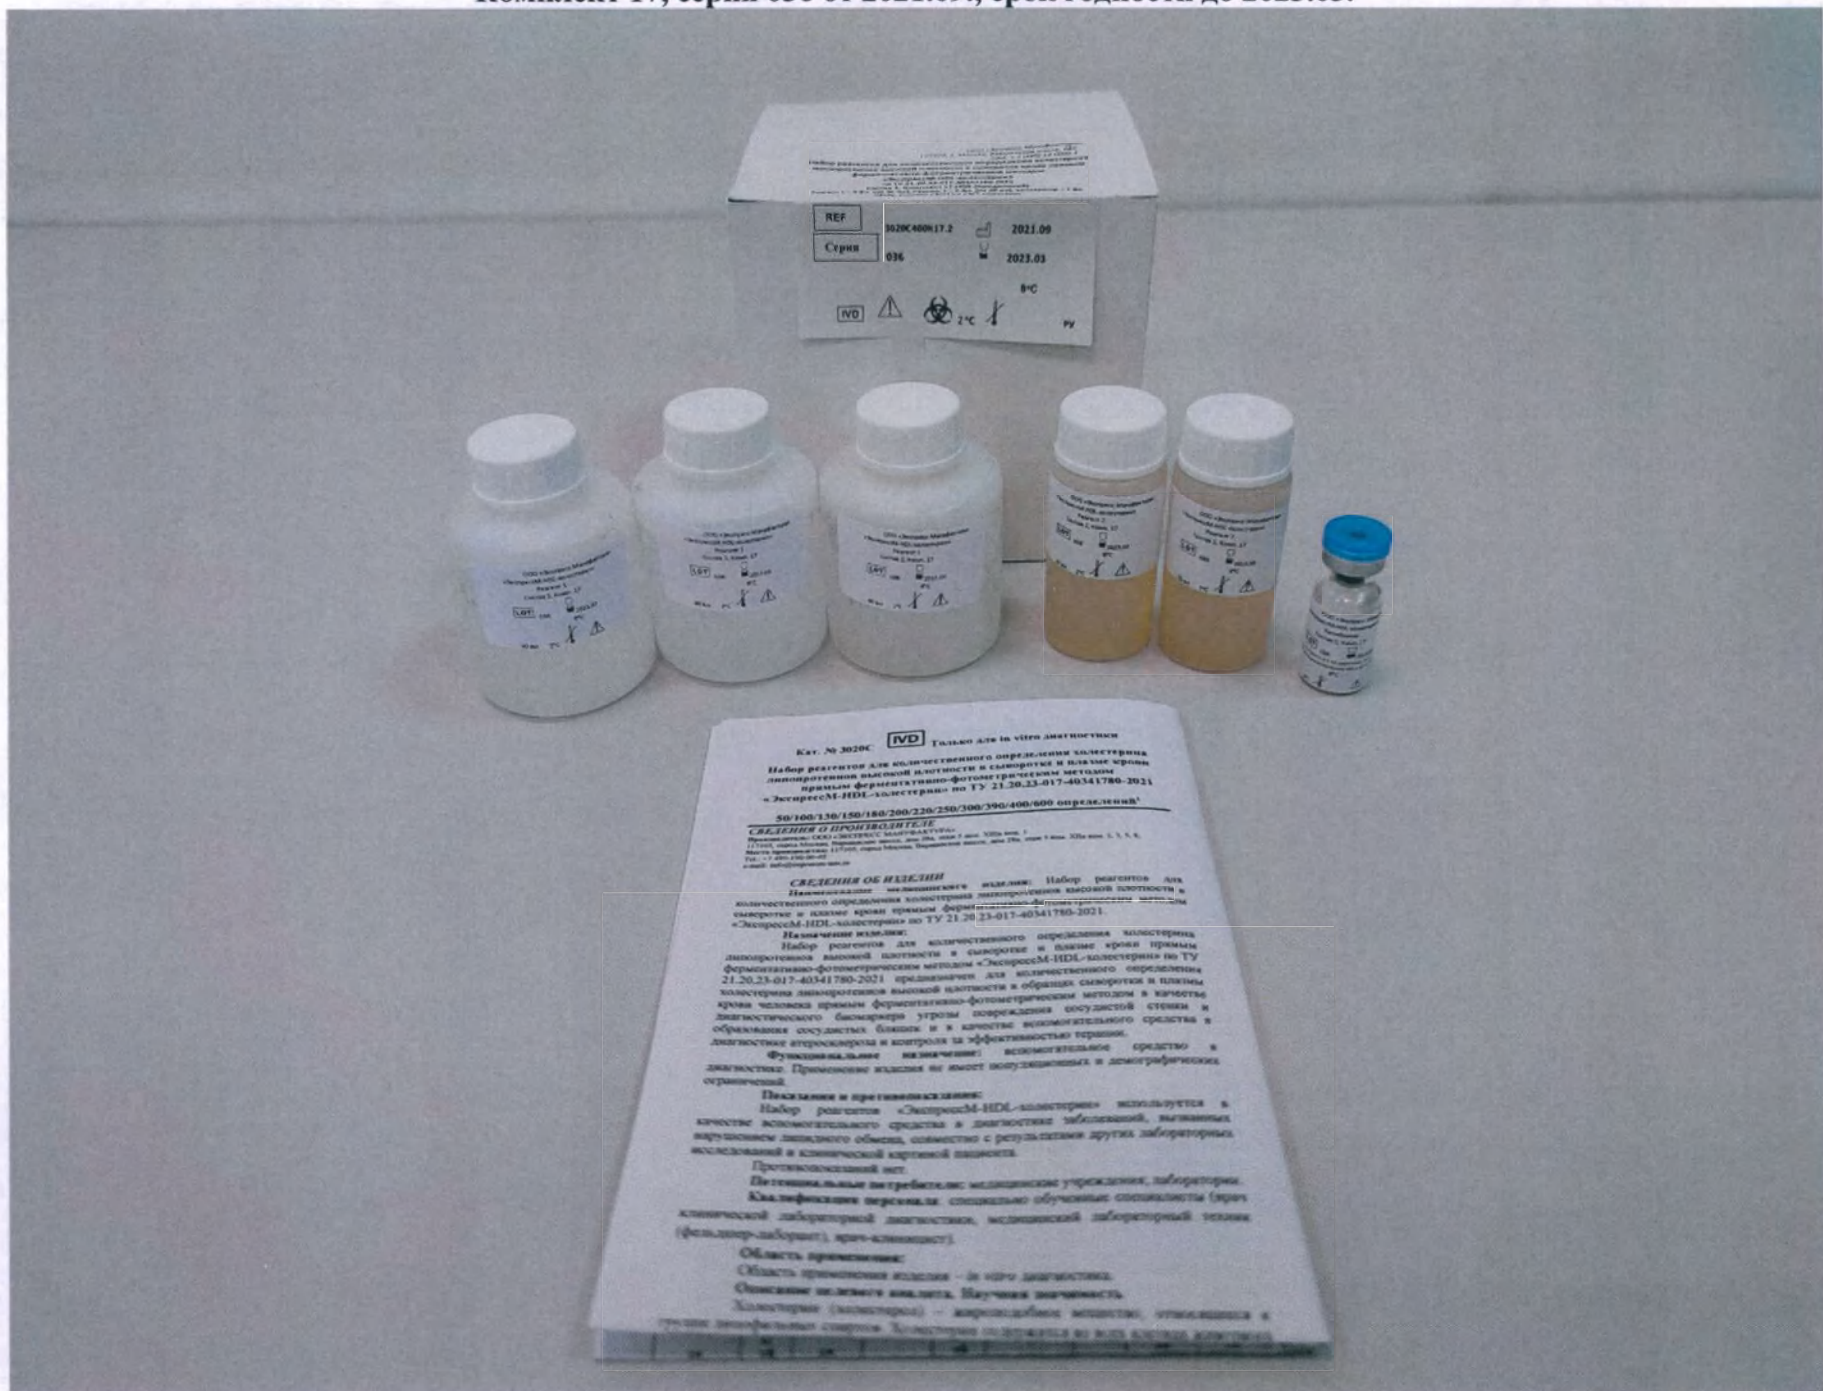

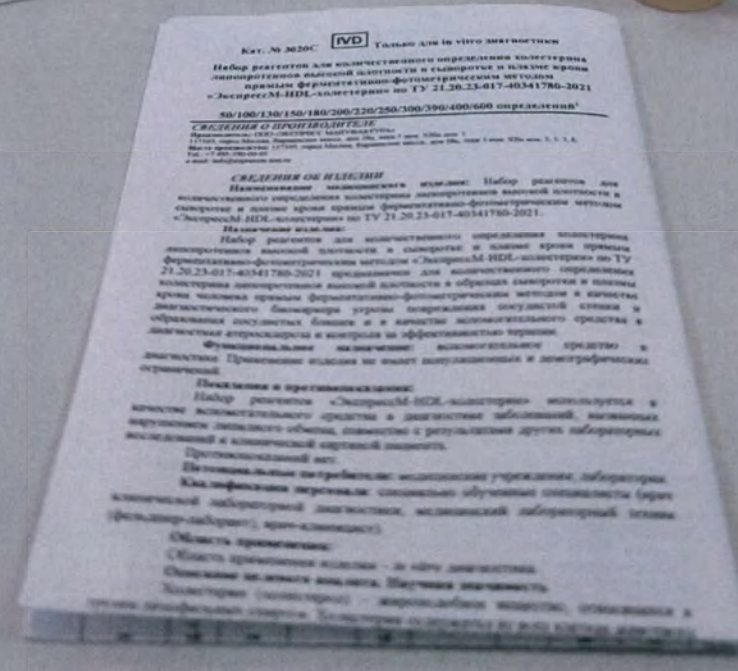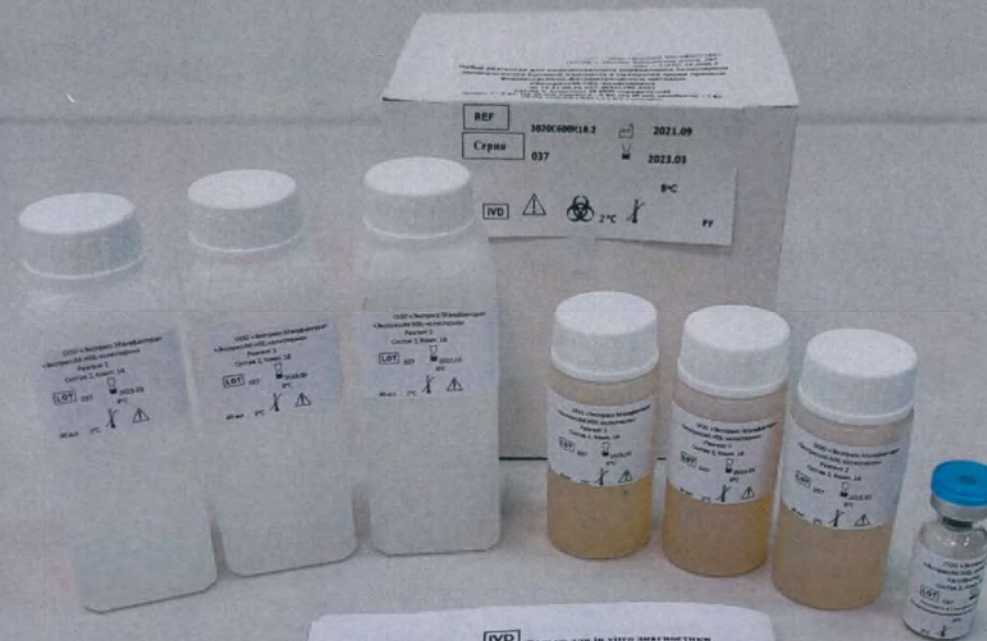

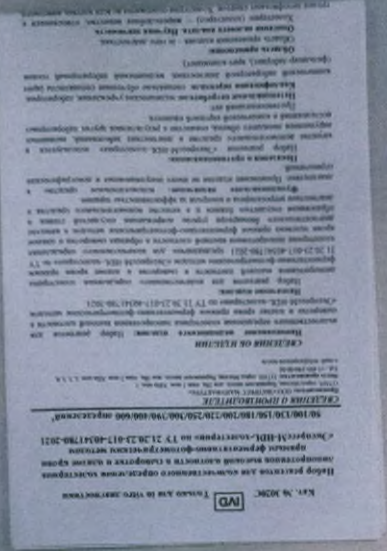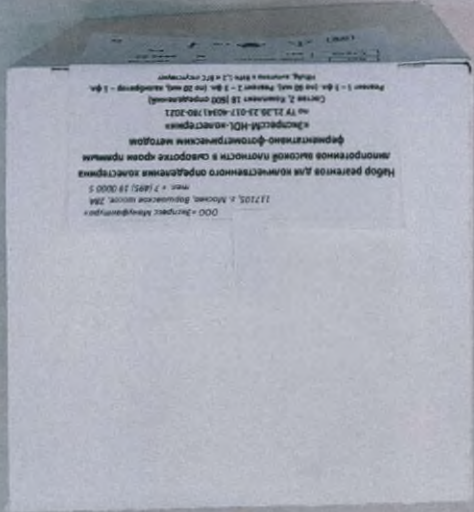

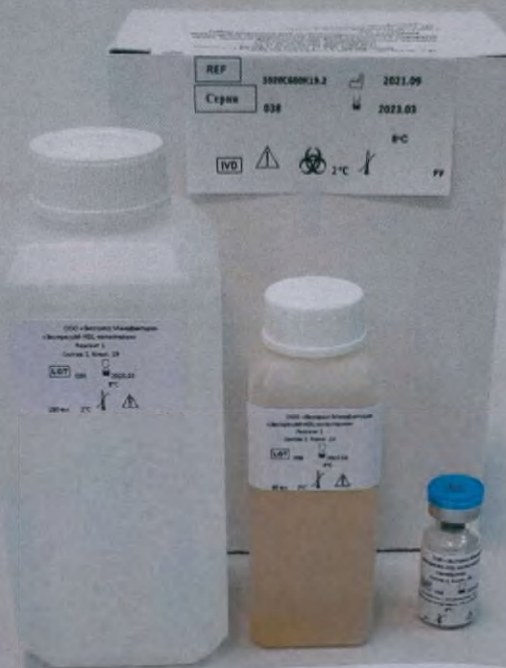

ИВД Только для in vitro диагностики
Кат. № 30300

Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови
Линейный диапазон: 0,5-10,0 ммоль/л
Применение: для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови методом фотоколориметрического метода

СВЕТЛЕНА О ПЕРИМЕТРЕ ТУ-16
Серия 038 от 2021.09. до 2023.03.
Срок годности: 24 месяца со дня выпуска

Назначение и применение:
Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови методом фотоколориметрического метода «Светлена О Периметре ТУ-16» применяется для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови методом фотоколориметрического метода в клинической лаборатории.

Противопоказания:
Противопоказаний нет.

Специальные инструкции:
Специальные инструкции отсутствуют.

Область применения:
Область применения изделия - in vitro диагностика.

Основные технические характеристики:
Характеристики изделия: жидкокристаллический дисплей, отображающий в графическом виде результаты измерений.

ООО «Вектор-Биофарм»
117216, г. Москва, Вузовская шоссе, 23А
тел +7 (495) 19 0000 5

**Набор реагентов для количественного определения
концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке
крови прямым ферментативно-фотометрическим методом**
«Экспресс-НДЛ-кофакторы»
по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021
Состав 1, Компонент 19 (500 опраделаний)
Реагент 1 - 1 фла. (250 мл), Реагент 2 - 1 фла. (50 мл), - калибратор - 1 фла.
Итого, упаковка в 3 фла. 1,2 л в 817 опраделаний



Кат. № 301С **IND** Упаковка для 1000 определений

Набор реагентов для количественного определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым ферментативно-фотометрическим методом
«Экспресс-НДЛ-кофакторы» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

№ 190.126.140.180.190.220.230.240.250.260.270.280.290.300 опраделаний

СЕРТИФИКАТ


Настоящим сертификатом подтверждается, что продукция, описанная в документе, соответствует требованиям, указанным в стандарте ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.

Выдан: 19.09.2021 г.

Подпись: _____

Место: _____

Срок действия: _____

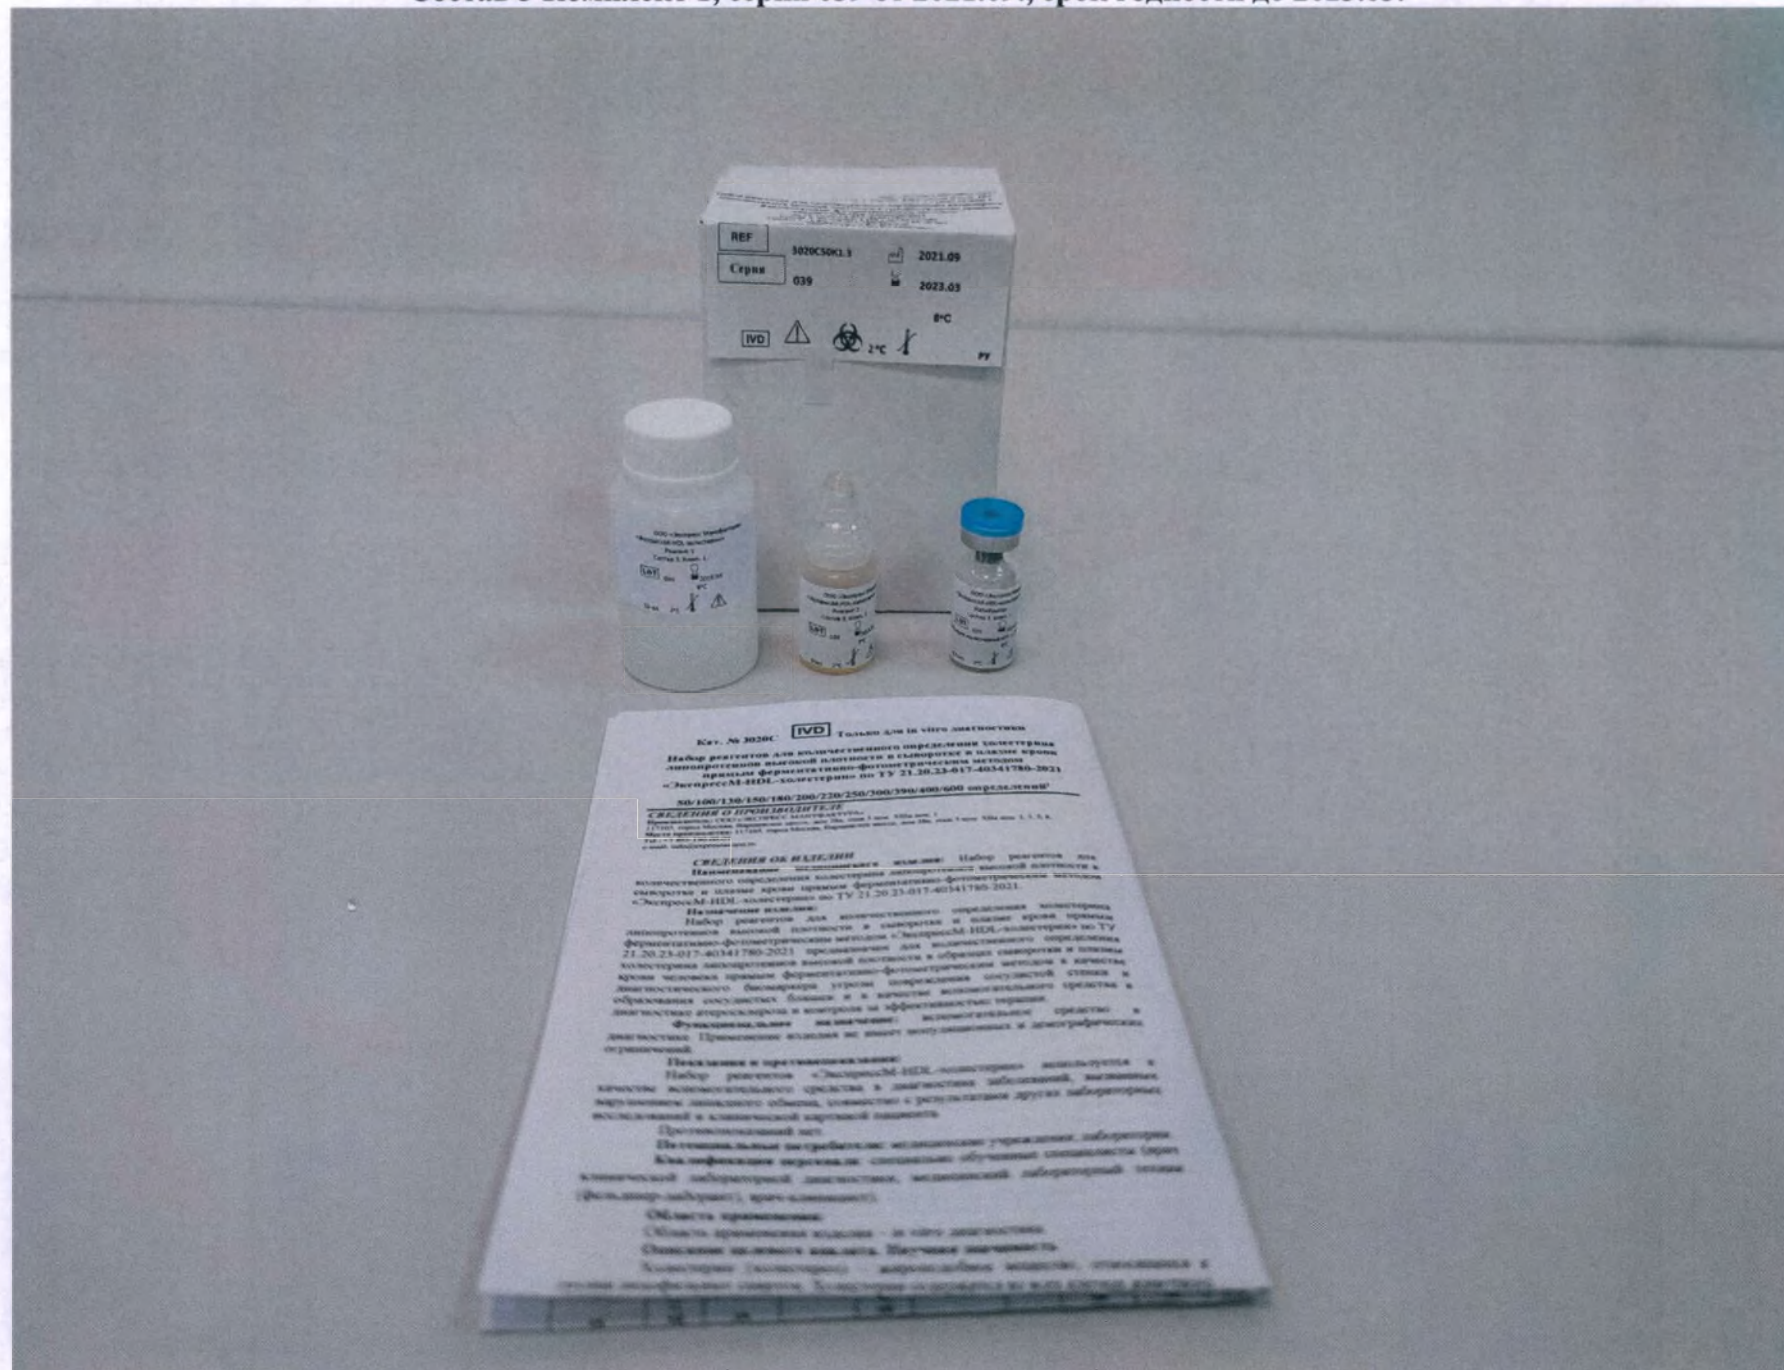



Набор реагентов для количественного определения содержания гемоглобина в сыворотке крови методом ферментативно-фотометрическим методом

Состав: 1. Сыворотка 2. 1000 (0,1%) раствор

Фасовка: 1 флакон 10 мл

Упаковка: 1 флакон 10 мл

117105, г. Москва, Восточное шоссе, 28А

мск + 7 (495) 19 0000 5

ООО «Экспресс-МедиаФарм»

Набор реагентов для количественного определения содержания гемоглобина в сыворотке крови методом ферментативно-фотометрическим методом

Состав: 1. Сыворотка 2. 1000 (0,1%) раствор

Фасовка: 1 флакон 10 мл

Упаковка: 1 флакон 10 мл

117105, г. Москва, Восточное шоссе, 28А

мск + 7 (495) 19 0000 5

ООО «Экспресс-МедиаФарм»

Набор реагентов для количественного определения содержания гемоглобина в сыворотке крови методом ферментативно-фотометрическим методом

Состав: 1. Сыворотка 2. 1000 (0,1%) раствор


Фасовка: 1 флакон 10 мл


Упаковка: 1 флакон 10 мл

117105, г. Москва, Восточное шоссе, 28А

мск + 7 (495) 19 0000 5

ООО «Экспресс-МедиаФарм»

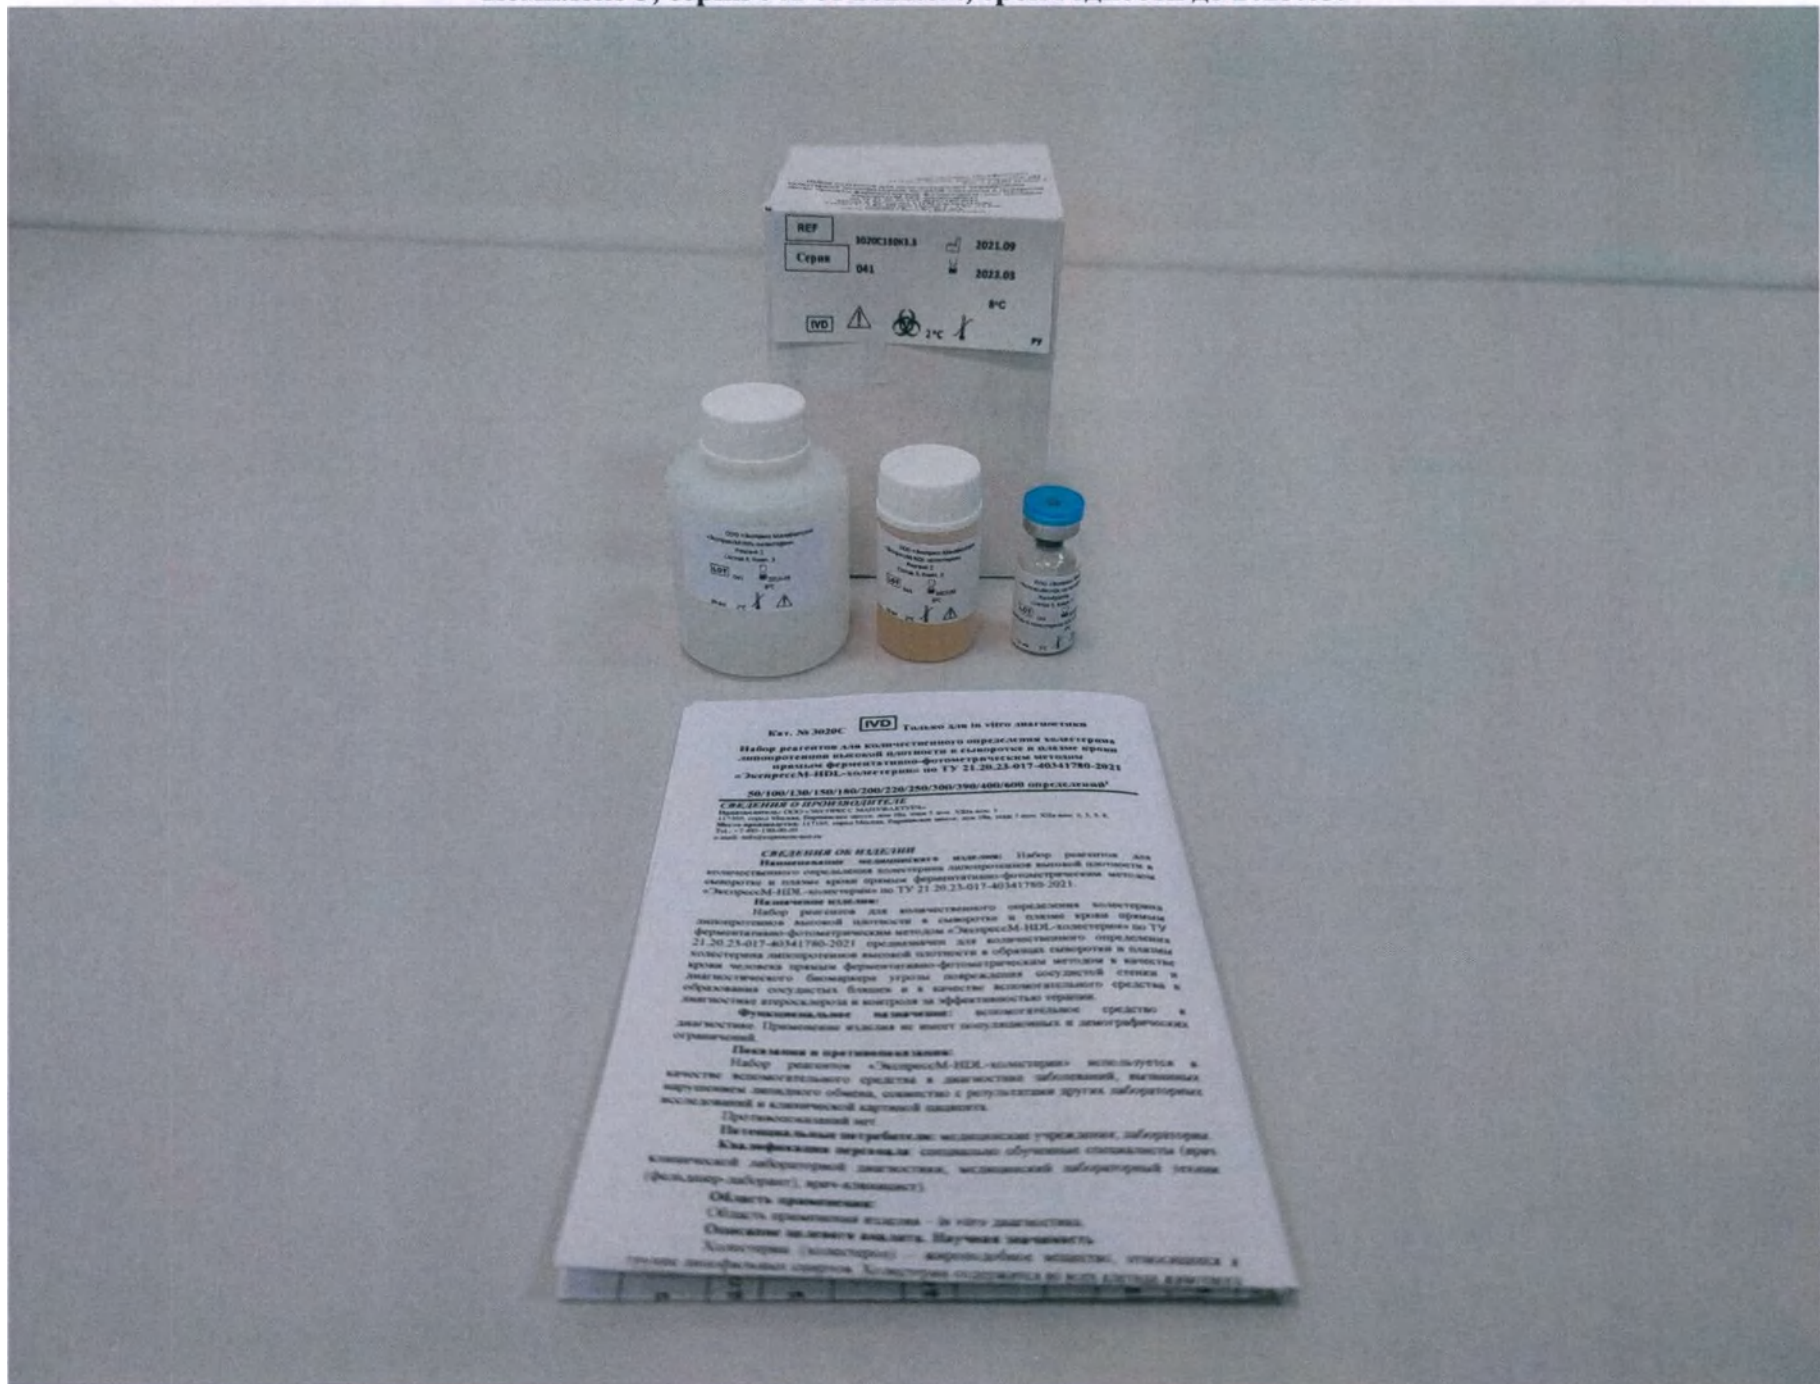

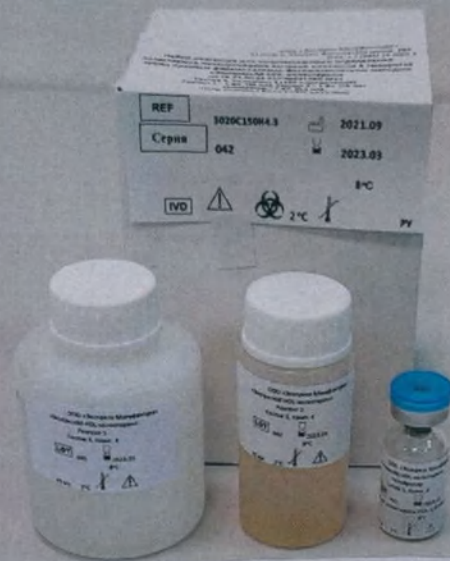


Кат. № 3030C **IVD** Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеиновой высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

50/100/150/180/200/220/250/300/390-400-600 определений*

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЦИРМИ» (ИНН 50/0700383)
 171001, г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1, лит. А, этаж 3
 Контактный телефон: 8 (800) 500-10-10, 8 (812) 304-40-01
 e-mail: info@cirm.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеиновой высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.
Назначение изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеиновой высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021 предназначен для количественного определения холестерина липопротеиновой высокой плотности в образцах сыворотки и плазмы крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве диагностического биомаркера у взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в качестве вспомогательного средства в диагностике атеросклероза и контроля за эффективностью терапии.
Функциональное назначение: вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не имеет противопоказаний и демографических ограничений.
Показания и противопоказания: Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» используется в качестве вспомогательного средства в диагностике заболеваний, вызванных нарушением липидного обмена, совместно с результатами других лабораторных исследований и клинической картиной пациента.
Противопоказаний нет.
Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
Квалификация персонала: специально обученные специалисты (врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист).
Область применения: Область применения изделия – in vitro диагностика.
Описание метода анализа. Научная значимость.
Холестерин (холестерин) – жирорастворимое вещество, относящееся к группе липофильных спиртов. Холестерин содержится во всех клетках организма.

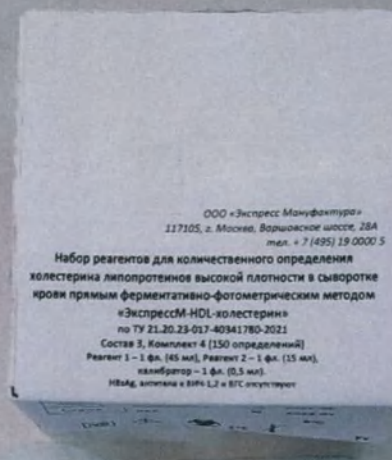

Кат. № 3020С **IVD** Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

50/100/130/150/180/200/220/250/300/390/400/600 определений*

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производителем ООО «Экспресс Мануфактура» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, этаж 1 этаж, 7330 кв. м)
 Немецкая компания: IIT-Opt, г. Гамбург, Германия (полное наименование: IIT-Opt GmbH, 22303 Гамбург, Германия)
 *по 15 определений на флакон

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021
 Назначение изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021 предназначен для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве диагностического биомаркера уровня повреждения сосудистой стенки и определения степени риска в качестве вспомогательного средства в диагностике атеросклероза и контроля за эффективностью терапии.
 Функциональное назначение: вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не имеет противопоказаний и ограничений по применению.
 Упаковка и противопоказания: Набор реагентов «ЭкспрессМ-HDL-холестерин» используется в качестве вспомогательного средства в диагностике заболеваний, вызванных нарушением липидного обмена, совместно с результатами других лабораторных исследований и клинической картиной пациента.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные и фактические медицинские учреждения, лаборатории: Калибровка проводится специально обученным специалистом (персонал клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный персонал (фельдшер-лаборант, врач-лаборант)).
 Область применения: Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание изделия/изделий, упаковки изделия: Холестерин (холестерин) – жирорастворимое вещество, относящееся к группе липофильных соединений. Холестерин содержится во всех клетках животного



Кат. № 3020C [IVD] Набор для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеиновой высокой плотности и триглицеридов в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

50/100/150/200/250/300/350/400/500 определяемых

УВЕЩЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ
 Предназначен для использования в лаборатории.
 Не использовать для диагностики.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеиновой высокой плотности и триглицеридов в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.

Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеиновой высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021 предназначен для количественного определения холестерина липопротеиновой высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве диагностического биомаркера угрозы повреждения сосудистой стенки и формирования сосудистых бляшек и в качестве вспомогательного средства в диагностике атеросклероза и контроля за эффективностью терапии.

Функциональное назначение: вспомогательное средство в диагностике. Применяется только на автоматизированных и демонстрационных анализаторах.

Показания и противопоказания:
 Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» используется в качестве вспомогательного средства в диагностике заболеваний, вызванных нарушением липидного обмена, совместно с результатами других лабораторных исследований и клинической картиной пациента.

Противопоказаний нет.

Клинические пользователи: медицинские учреждения, лаборатории.

Квалификационные требования: специально обученный персонал (врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный персонал (фельдшер-лаборант), врач-клинист).

Область применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание целевого анализа: Научная значимость.

Холестерин (холестерин): жирорастворимое вещество, относящееся к классу липофильных спиртов. Холестерин присутствует во всех клетках животных.

ООО «Экспресс Монофлуоранс»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 26А
тел. +7 (495) 19 6000 2

**Набор реагентов для количественного определения концентрации
липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови прямым
флуориметрико-фотометрическим методом**

«ЭкспрессМ-НД», «Анализаторы»
по ТУ 11.33.33.017-62/41.780-2021
Серия 3, Комплект 5 (180 определений)
Реактив 1 – 1 фла (54 мл), Реактив 2 – 1 фла (18 мл),
калибратор – 1 фла (0,3 мл).
рН-буф. емкость в Бюх 1,2 и ВТС отсутствует



Кат. № 3029С  **Упаковка для 180 определений**

**Набор реагентов для количественного определения концентрации
липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови
прямым флуориметрико-фотометрическим методом**

«ЭкспрессМ-НД», «Анализаторы» по ТУ 11.33.33.017-62/41.780-2021

50 (100/150/180/200/250/300/390/400/600 определений)


СВЯЗАННО С ПРОИЗВОДСТВОМ
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 26А, этаж 5 пом. 20А-001
тел. +7 (495) 19 6000 2
fax +7 (495) 19 6000 3
e-mail: info@expmoss.ru


Назначение, назначение, класс Набор реагентов для
количественного определения концентрации липопротеинов
высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым
флуориметрико-фотометрическим методом

Набор реагентов для количественного определения концентрации
липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым
флуориметрико-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-НД», «Анализаторы» по ТУ
11.33.33.017-62/41.780-2021. Набор реагентов для количественного определения
концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме
крови включает реактивы флуориметрико-фотометрическим методом в качестве
реактива 1 – 1 фла (54 мл), реактива 2 – 1 фла (18 мл), калибратора – 1 фла (0,3 мл).
Объемная емкость в Бюх 1,2 и ВТС отсутствует.

Показатели и критерии качества
Набор реагентов для количественного определения концентрации
липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым
флуориметрико-фотометрическим методом «ЭкспрессМ-НД», «Анализаторы» по ТУ
11.33.33.017-62/41.780-2021. Набор реагентов для количественного определения
концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме
крови включает реактивы флуориметрико-фотометрическим методом в качестве
реактива 1 – 1 фла (54 мл), реактива 2 – 1 фла (18 мл), калибратора – 1 фла (0,3 мл).
Объемная емкость в Бюх 1,2 и ВТС отсутствует.

Область применения
Область применения – для определения концентрации липопротеинов
высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым флуориметрико-
фотометрическим методом.

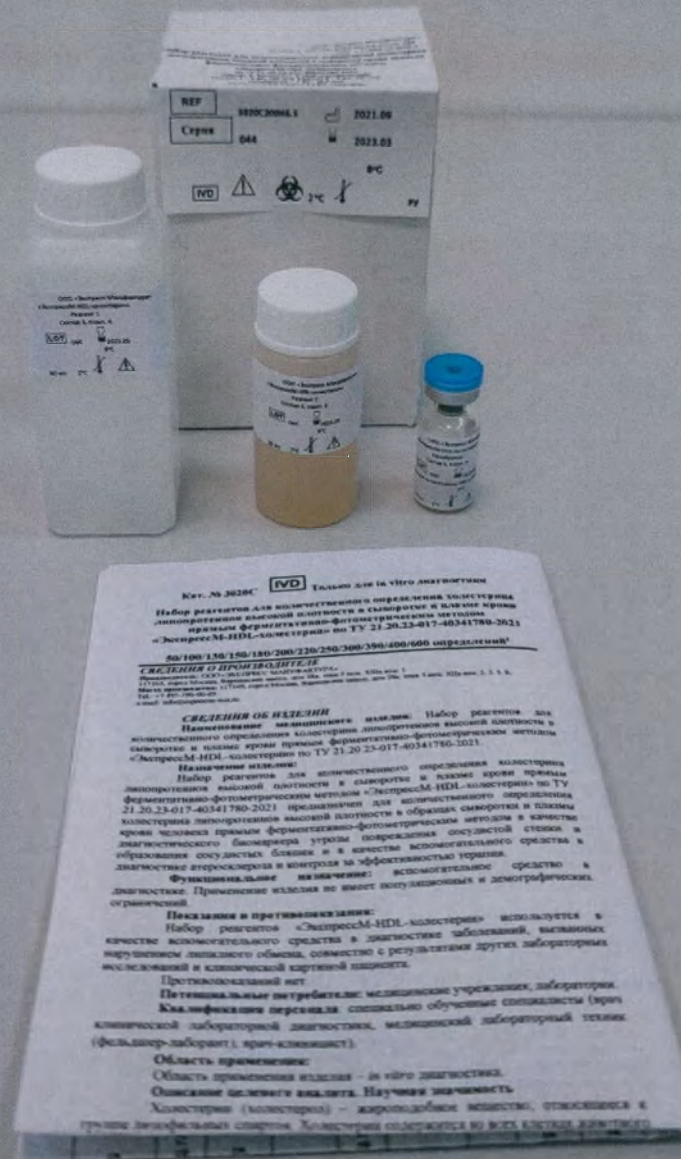

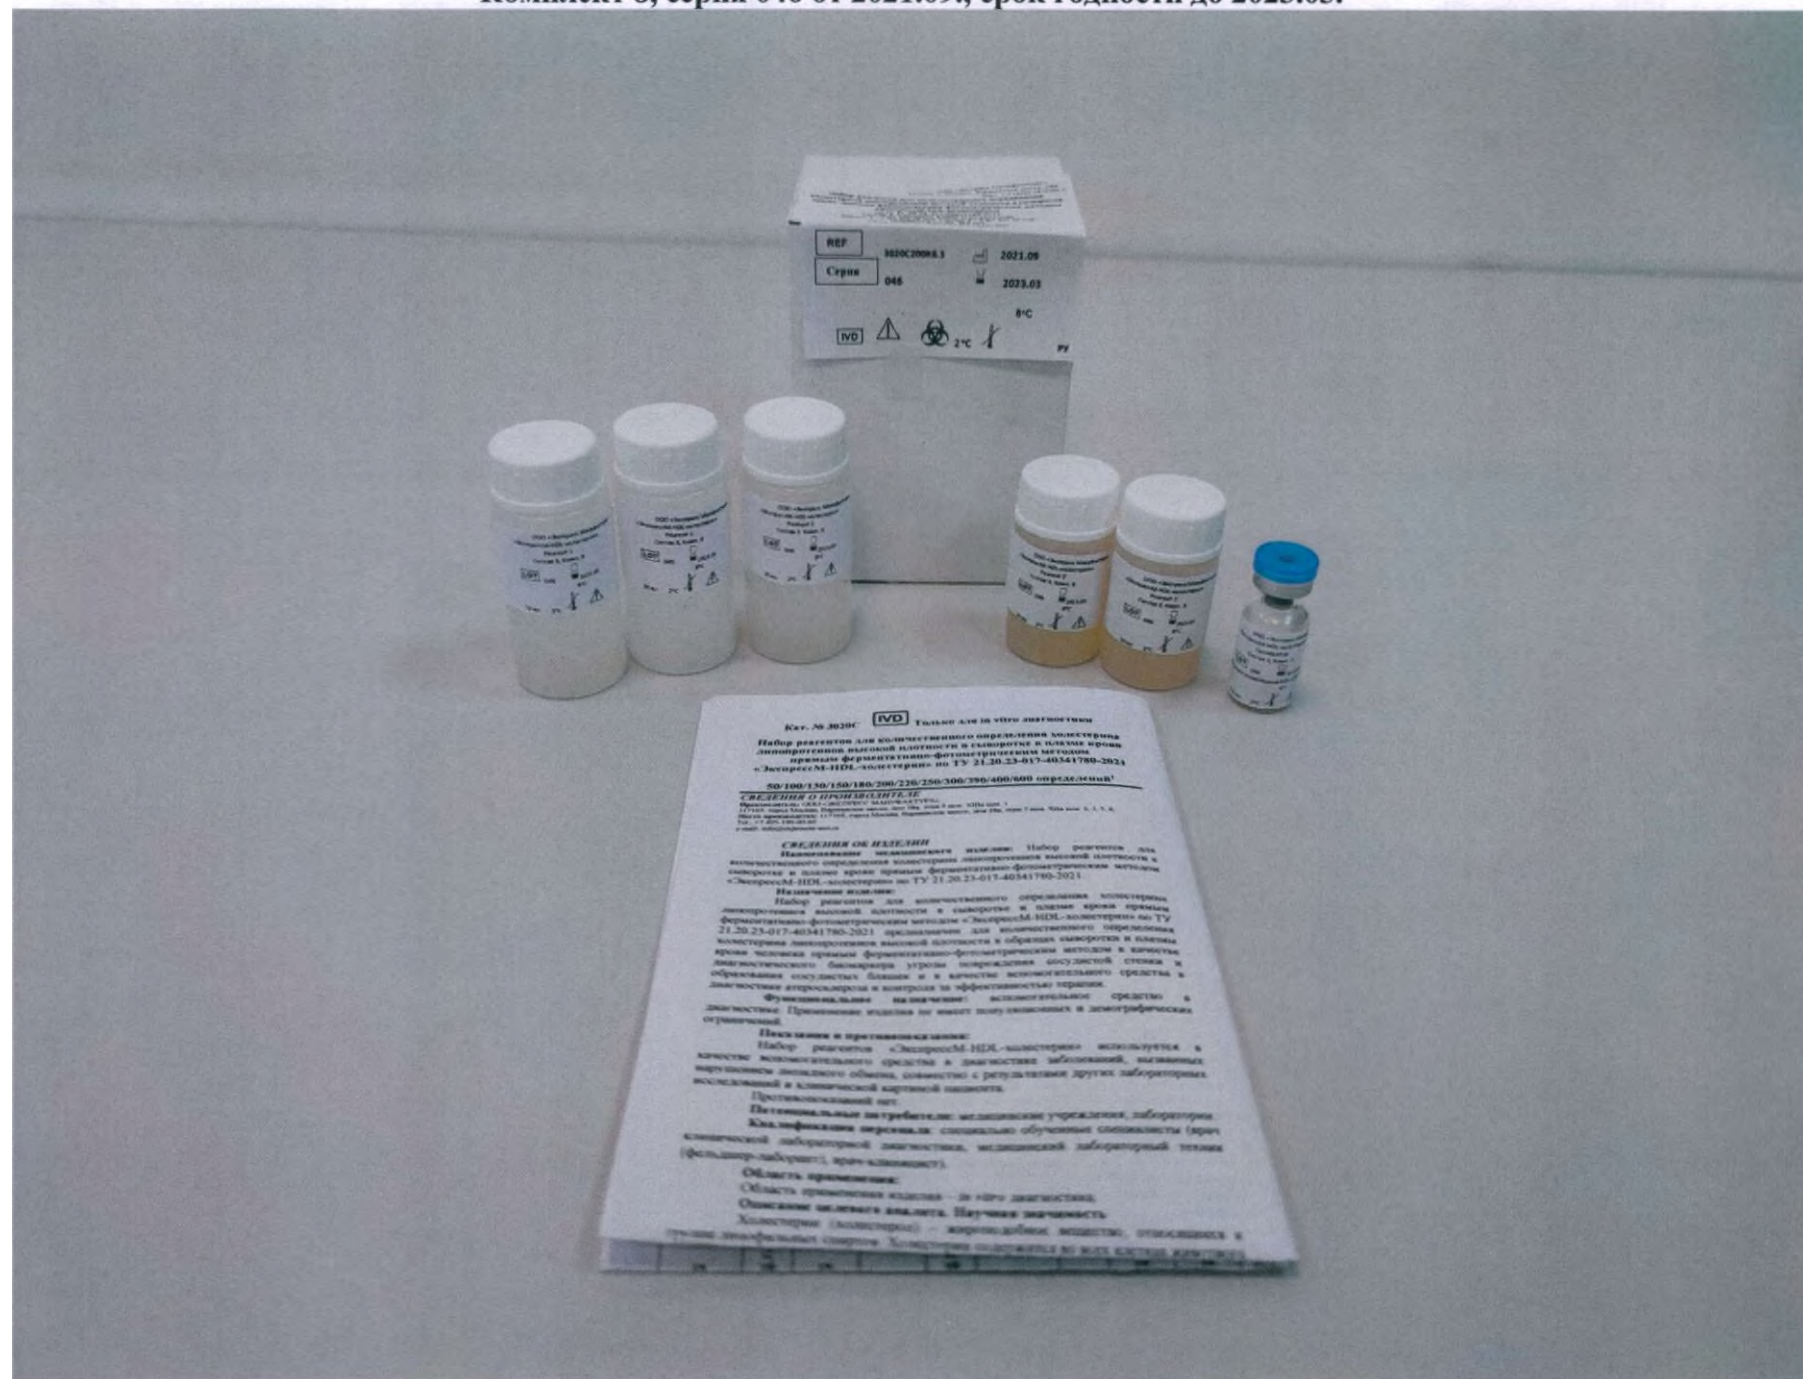



[illegible]



Набор реагентов для количественного определения липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови при помощи ферментативно-фотометрическим методом


«Амтест»-НД-Колюстрин»
№ 17.20.33-017-А041780-2021
Состав: 3, Колюстрин в 1200 порцелин
Реагент 1 - 3 фл. (по 20 мл), Реагент 2 - 2 фл. (по 10 мл),
Камистор - 1 фл. (0,5 мл)
Индикатор в виде 1,2 и ВГ отгружаются


ООО «Экспресс-МедиаФарма»
117105, А. Москва, Восточное шоссе, 28А
т/ф +7 (495) 19 0000 5

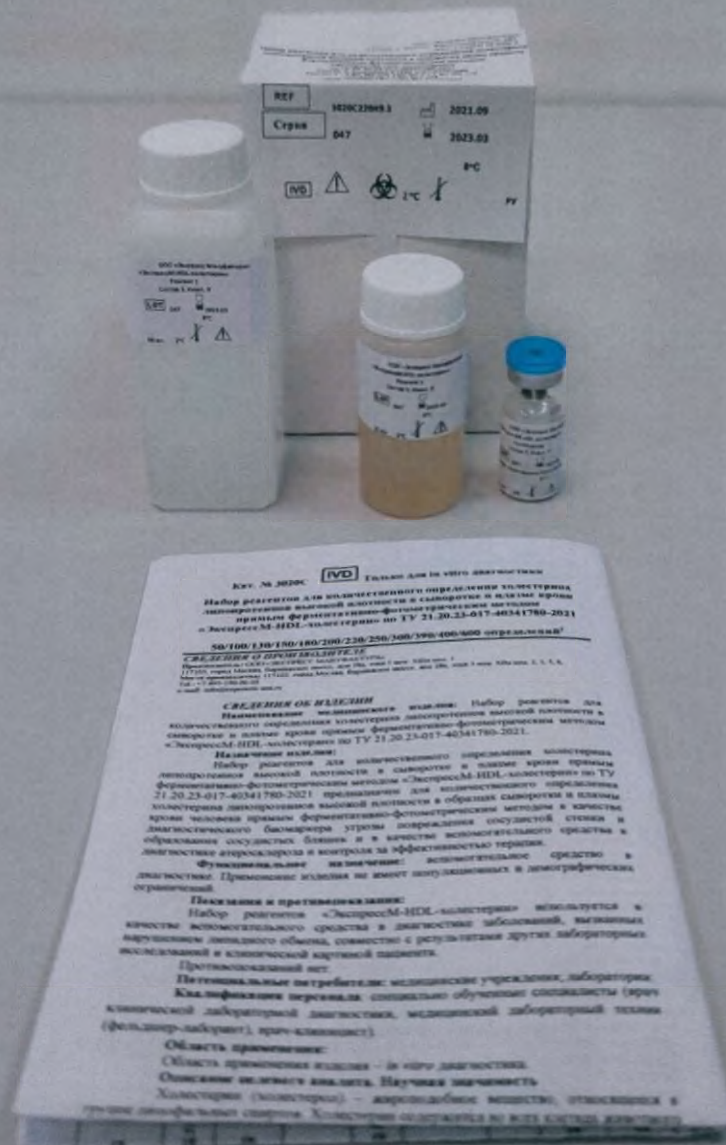

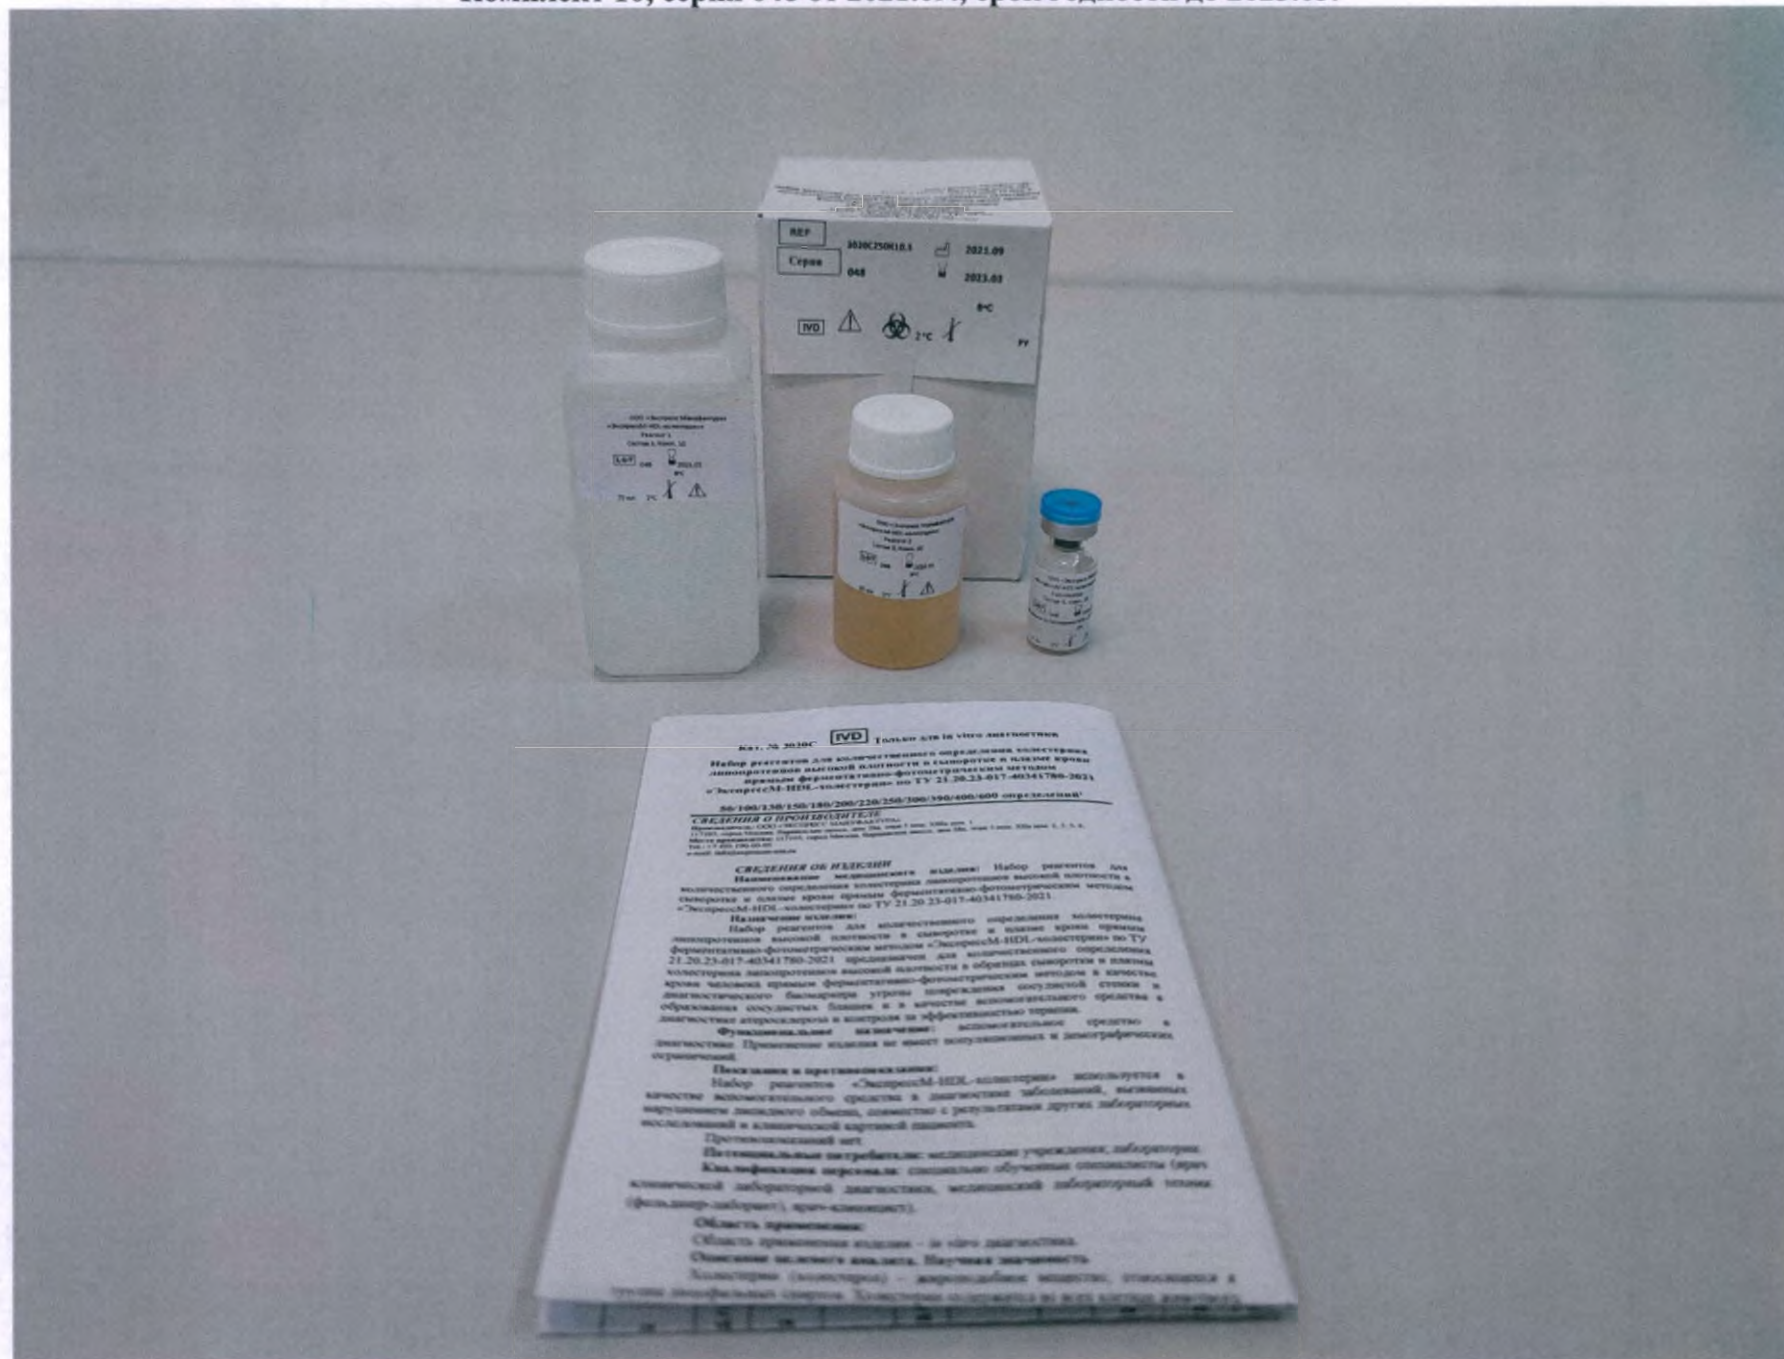

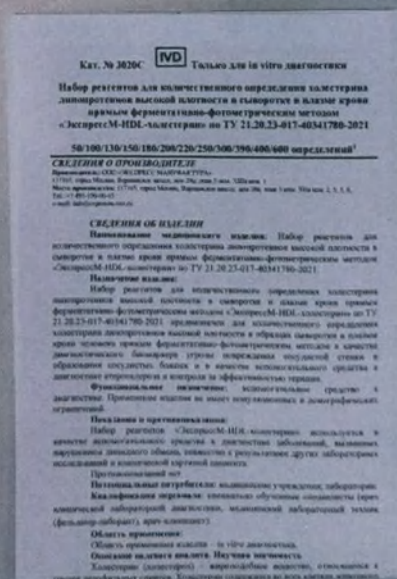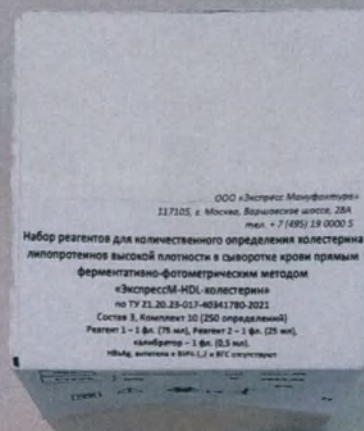

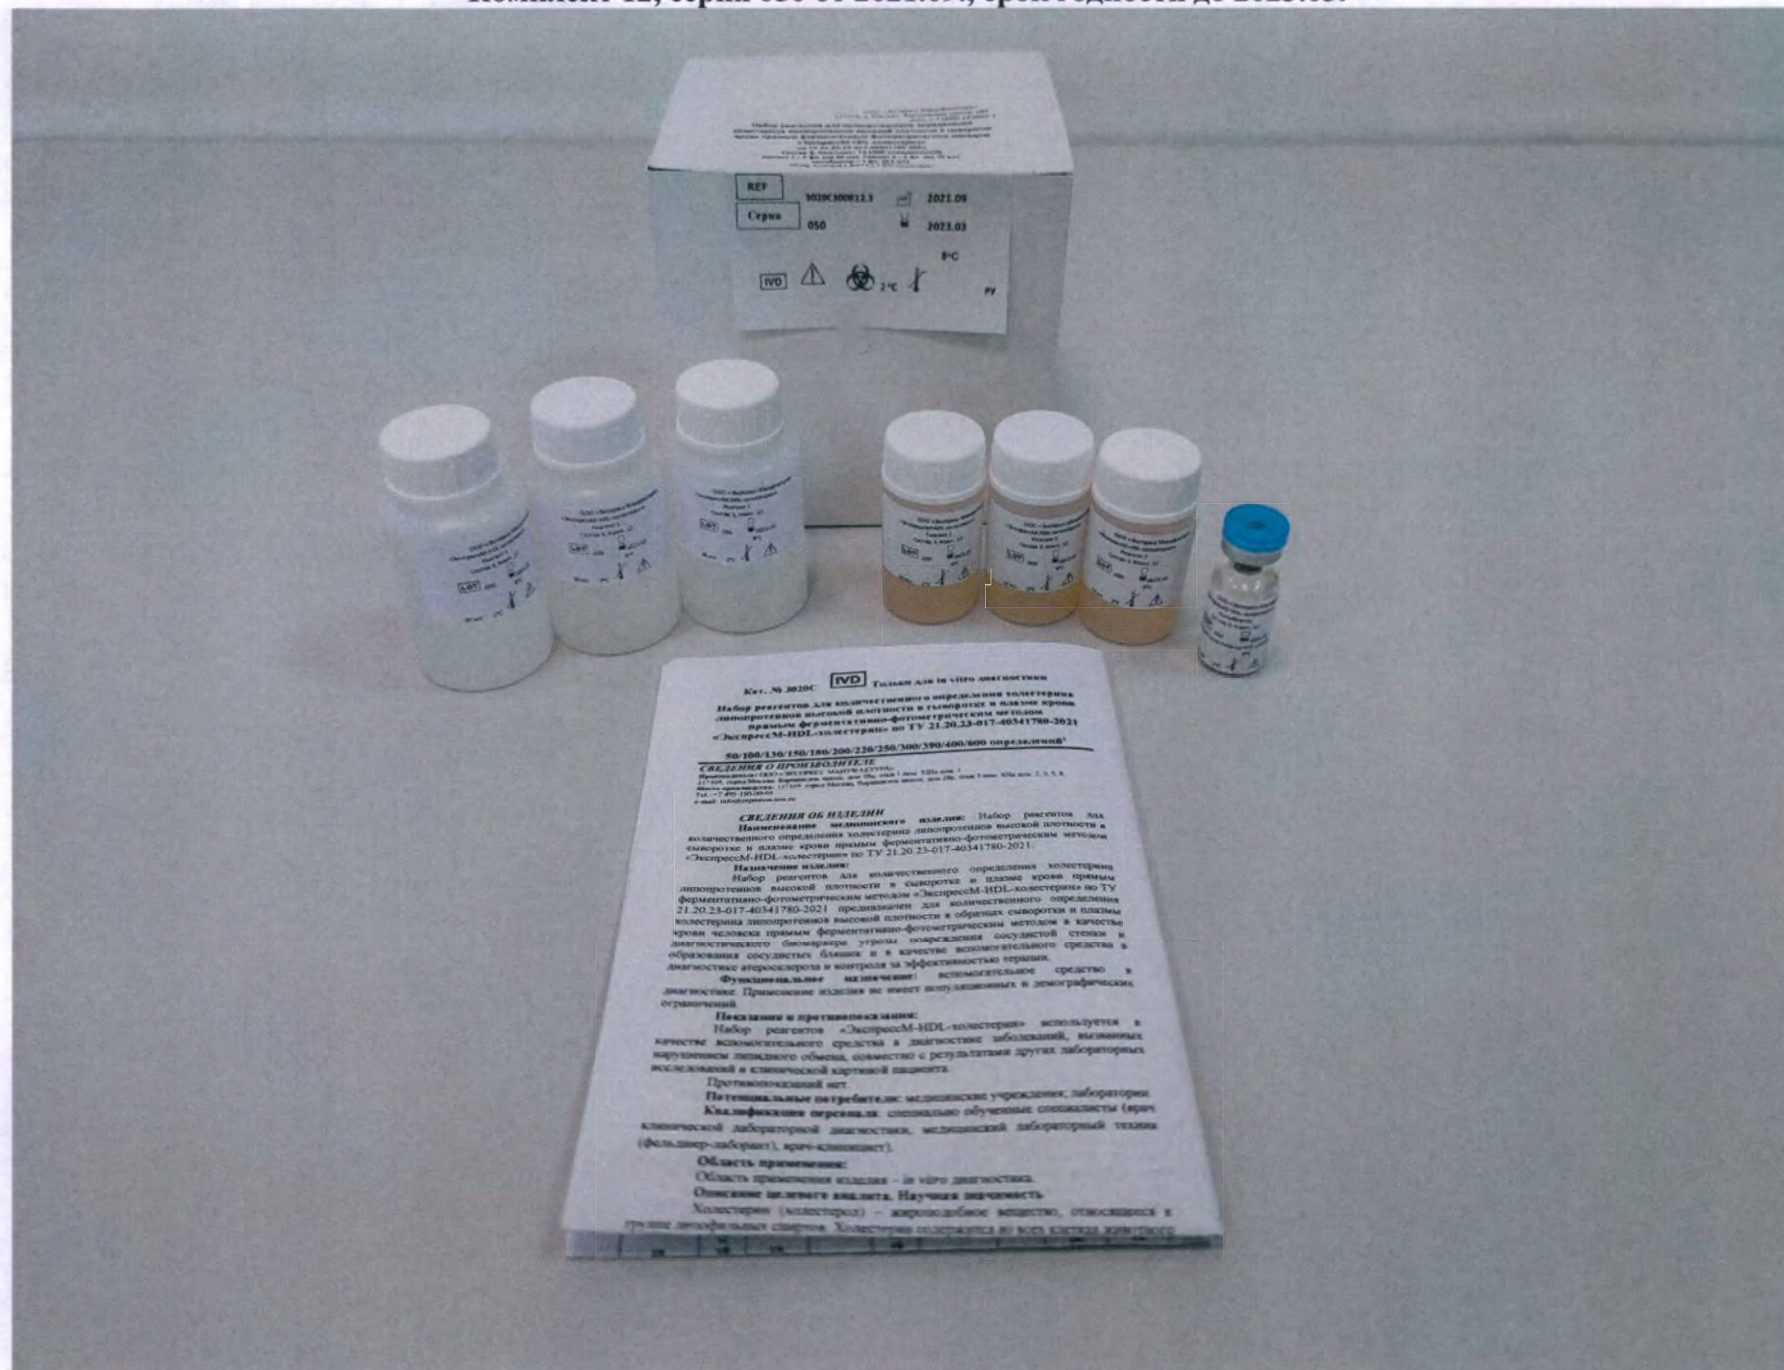

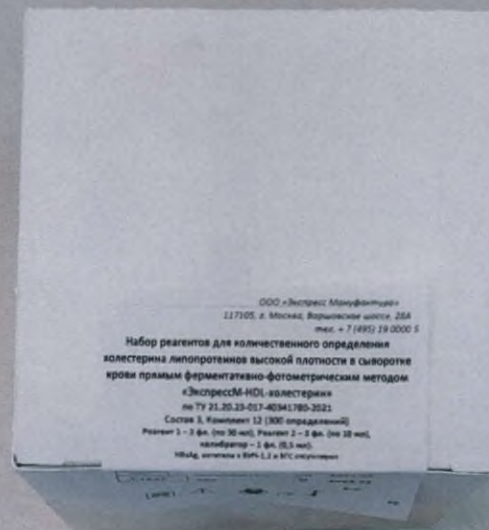

Кат. № 3020C **IVD** Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021

50/100/130/150/180/200/220/250/300/390/400/480 определений*

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Произведено в ООО «Экспресс-МедиаФарм»
 127107, г. Москва, Варшавский шоссе, д. 26А, пом. 1-й этаж, 403-й этаж
 Место производства IVD: 117105, г. Москва, Варшавский шоссе, д. 26А, пом. 1-й этаж, 403-й этаж, 1-й этаж, 403-й этаж

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
 Наименование исполнителя: ООО «Экспресс-МедиаФарм». Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021.

Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом «Экспресс-M-HDL-холестерин» по ТУ 21.20.23-017-40341780-2021, предназначен для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови прямым ферментативно-фотометрическим методом в качестве вспомогательного биоматериала при проведении лабораторных исследований в диагностике атеросклероза и контроля за эффективностью лечения.


Функциональные назначения: количественное определение холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови.



Показания к применению:
 Набор реагентов «Экспресс-M-HDL-холестерин» применяется в качестве вспомогательного средства в диагностике заболеваний, связанных с нарушением обмена липидов, особенно с нарушением уровня липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови.


Противопоказания: нет.


Назначение и область применения: предназначен для использования в лабораториях клинической диагностики, специализированных лабораториях (включая клинические лаборатории диагностики, специализированные лаборатории (федеральные, региональные, муниципальные)).

Область применения:
 (Желать применения изделия в in vitro диагностике)
 (Использовать изделие в качестве биоматериала)
 (Холестерин (холестерин) - жироподобное вещество, содержащееся в крови и тканях человека. Холестерин является важным компонентом клеточных мембран и предшественником для синтеза гормонов и витамина D.)

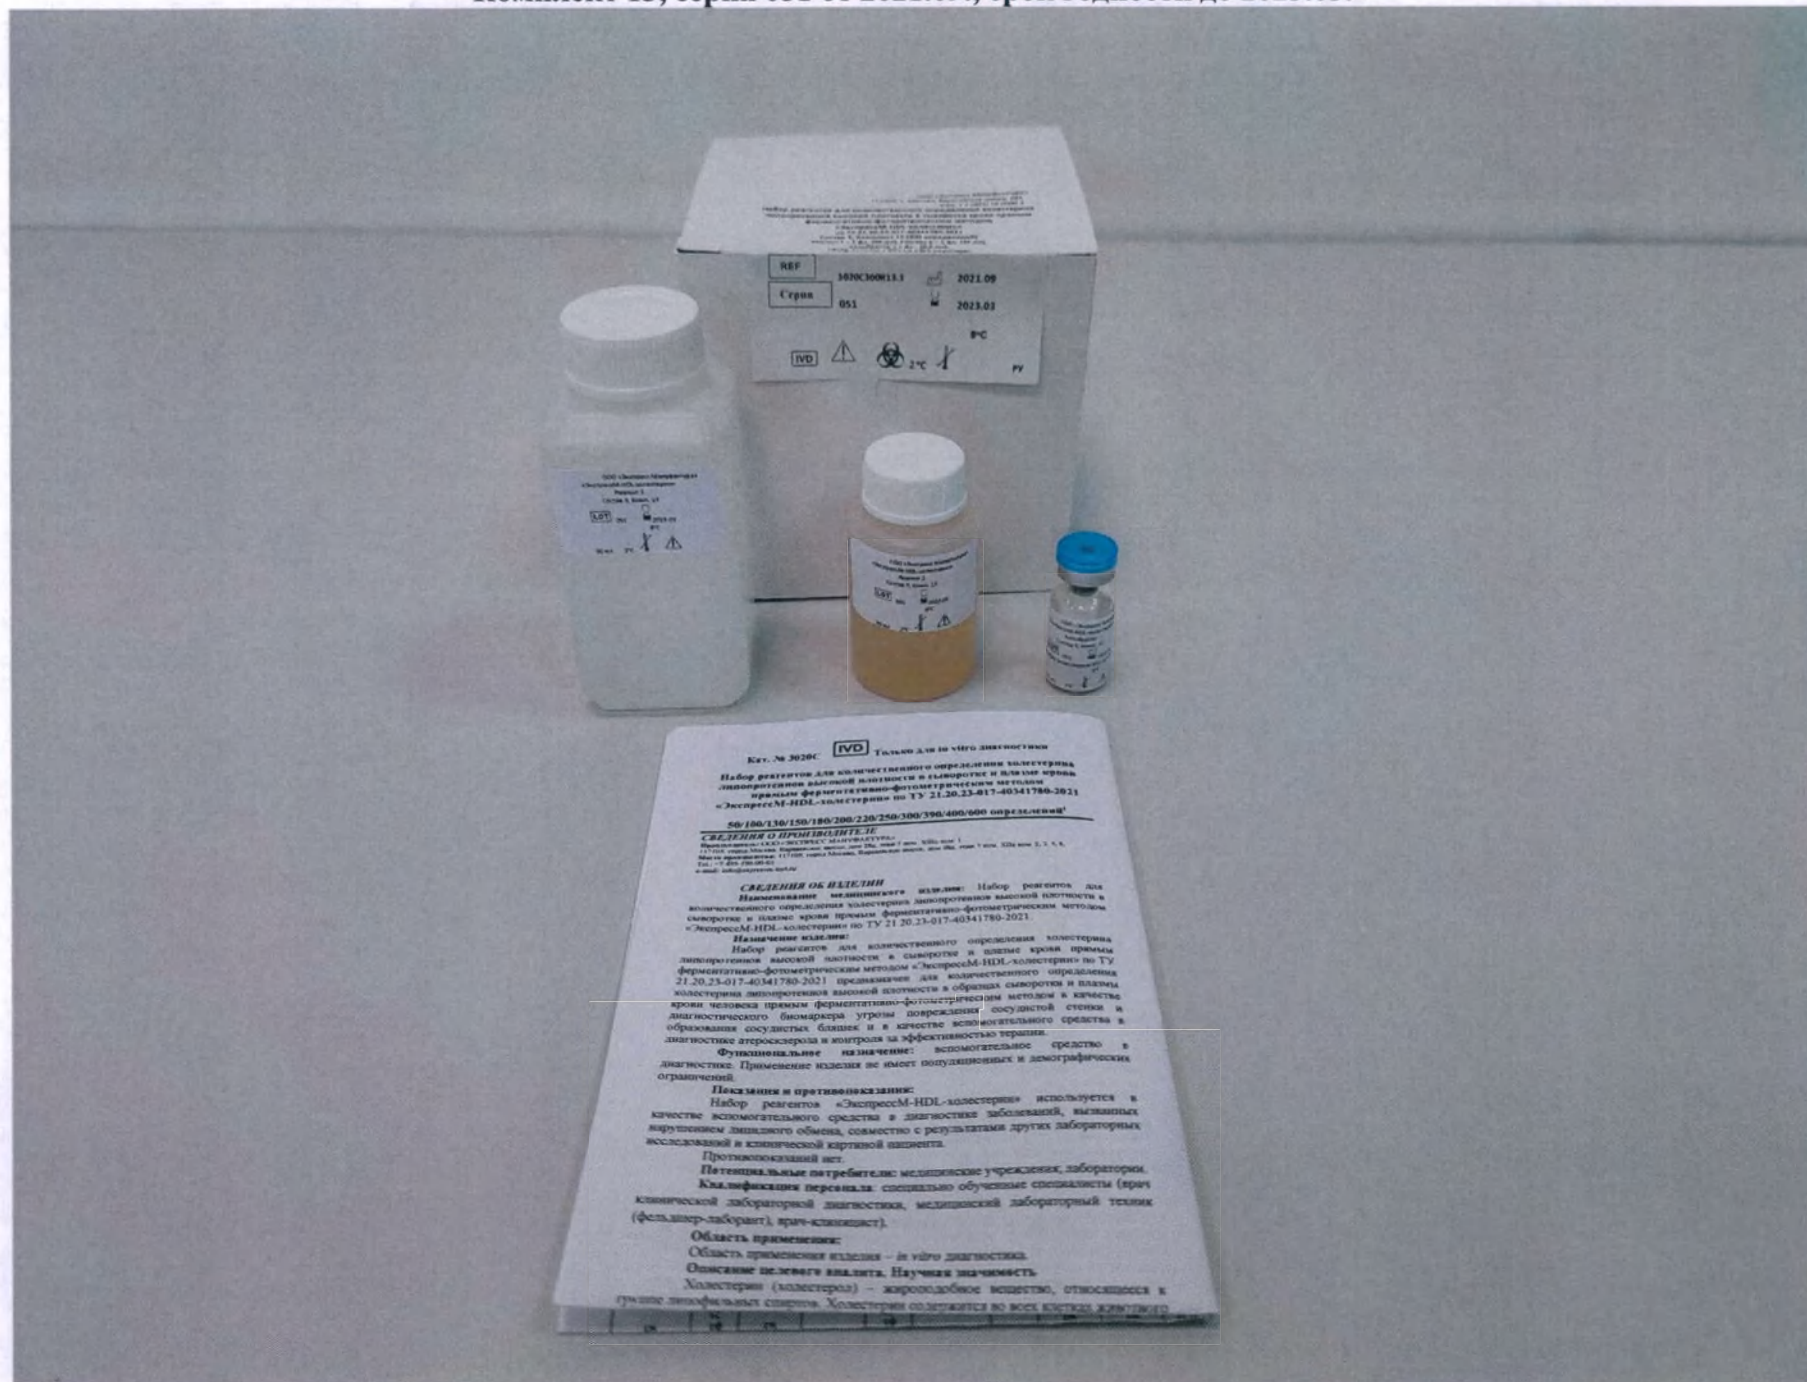


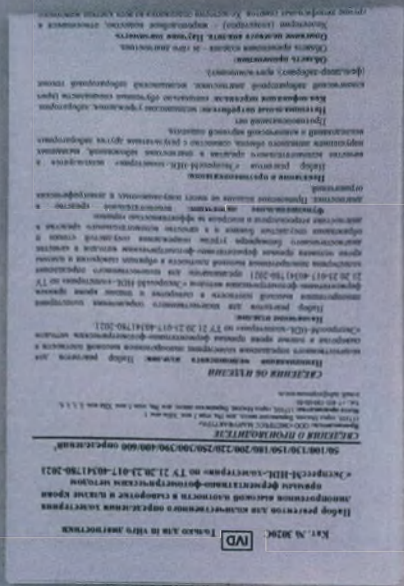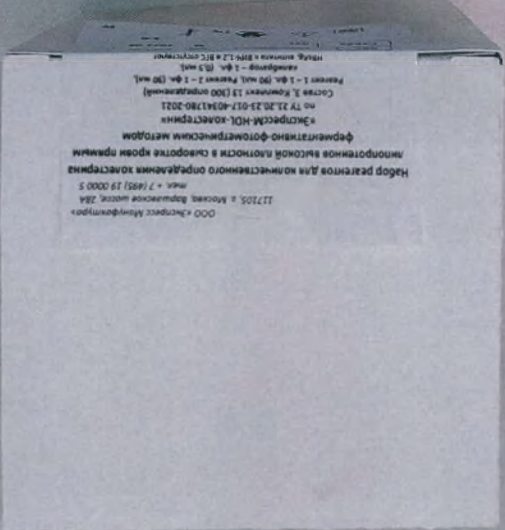

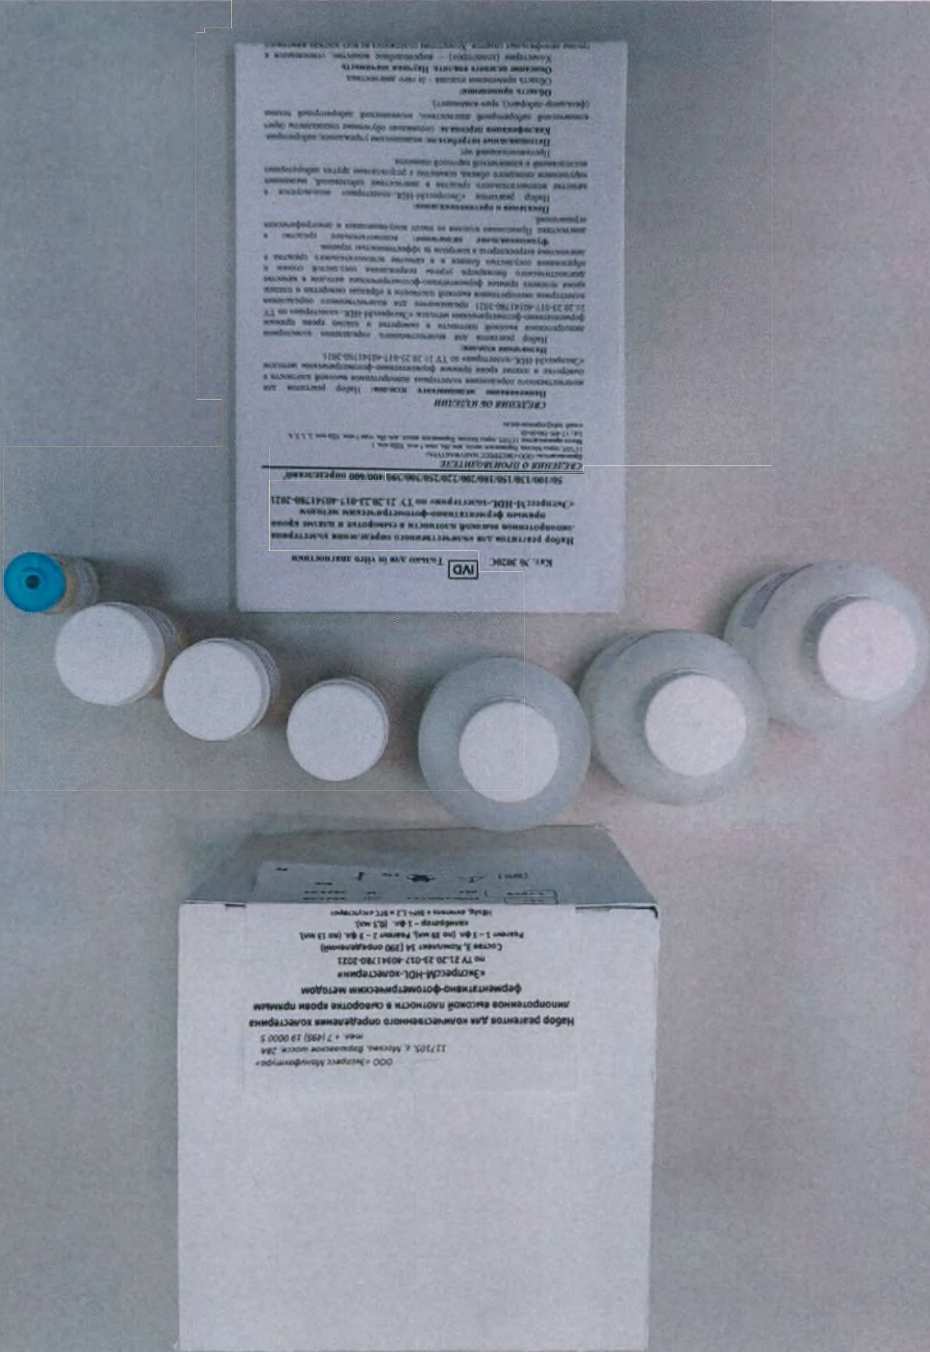

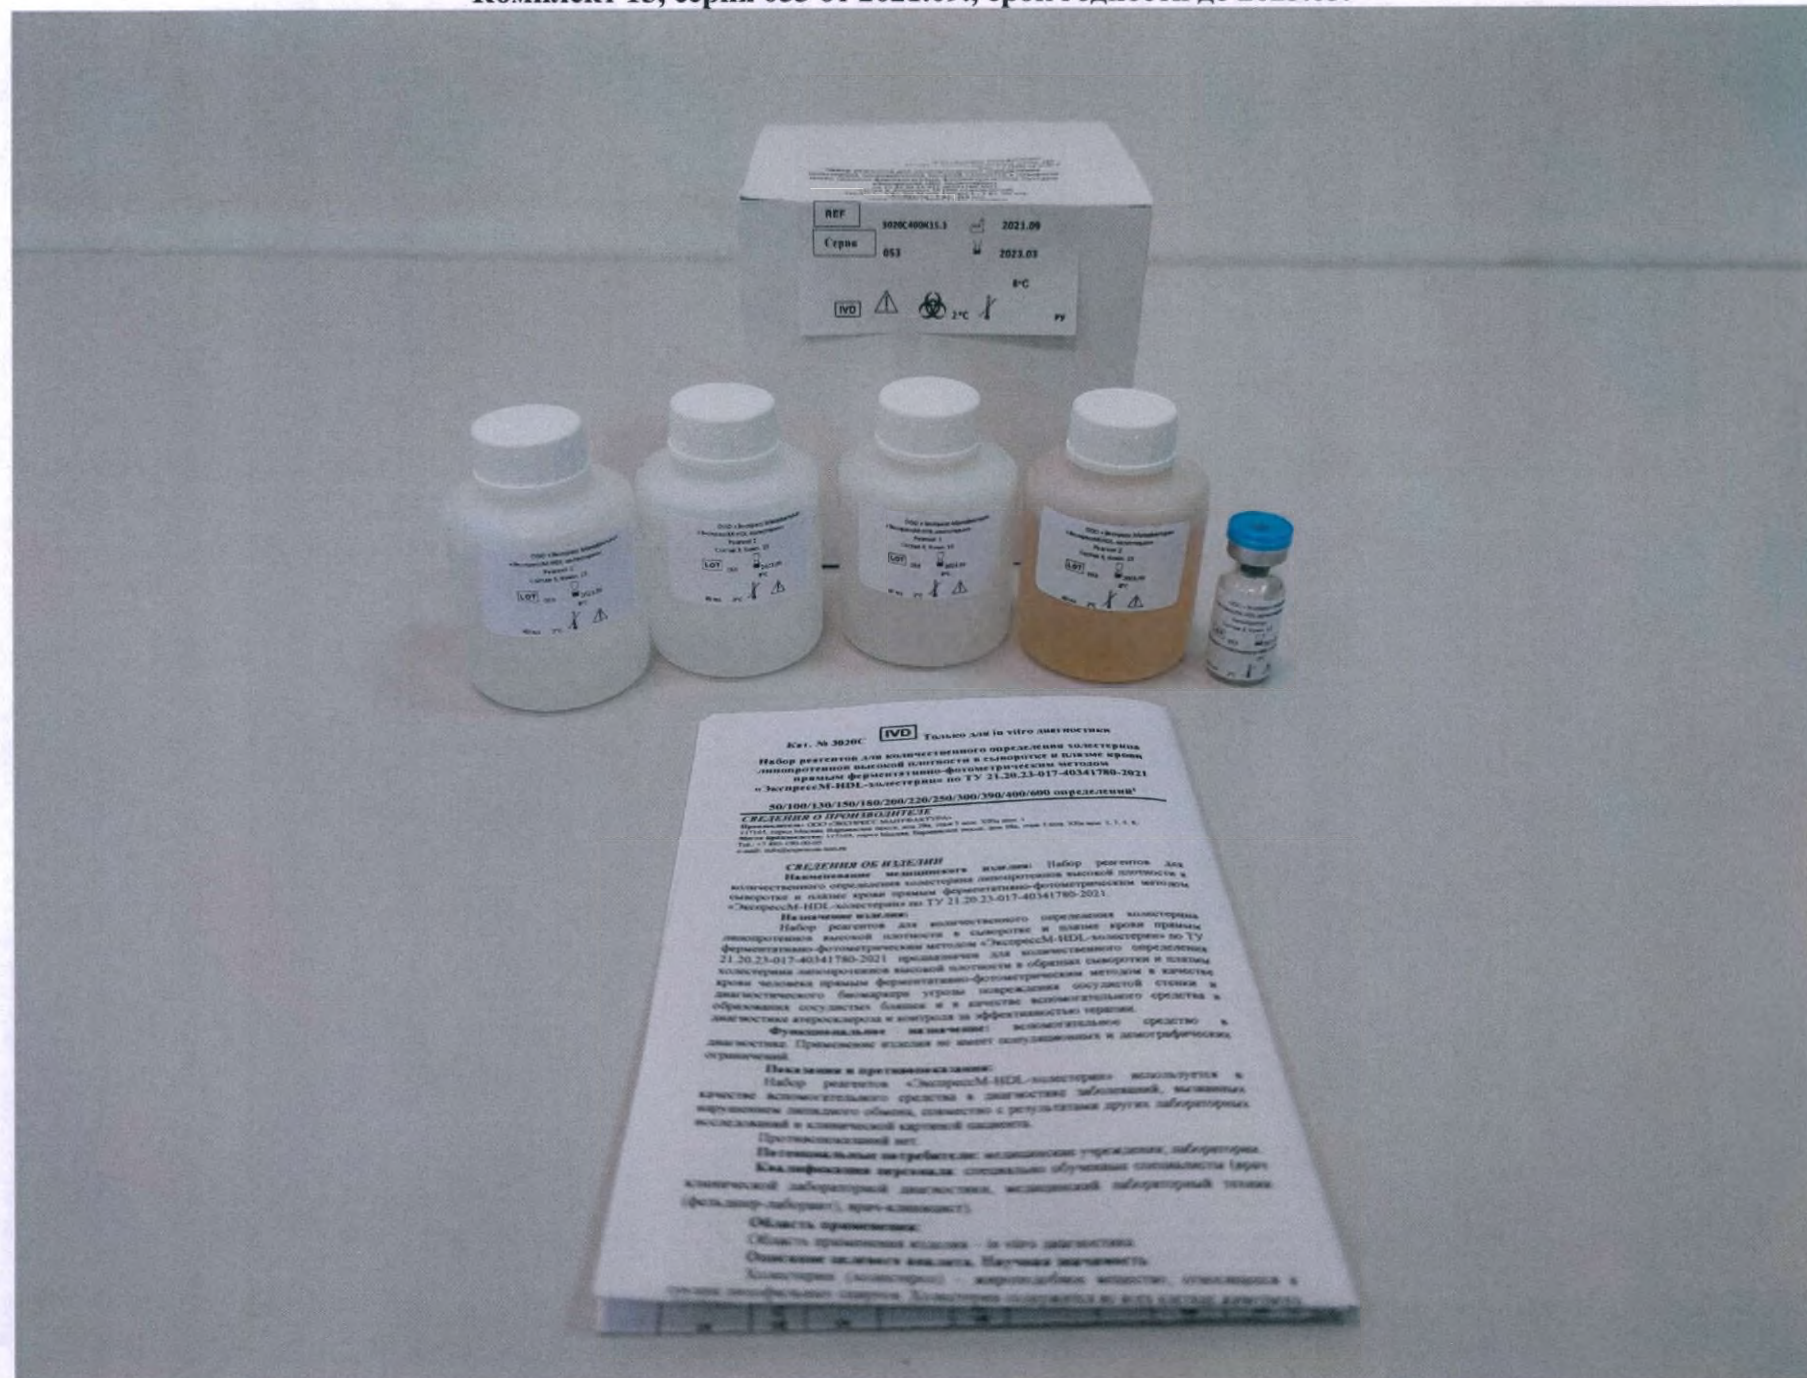

[illegible][illegible]

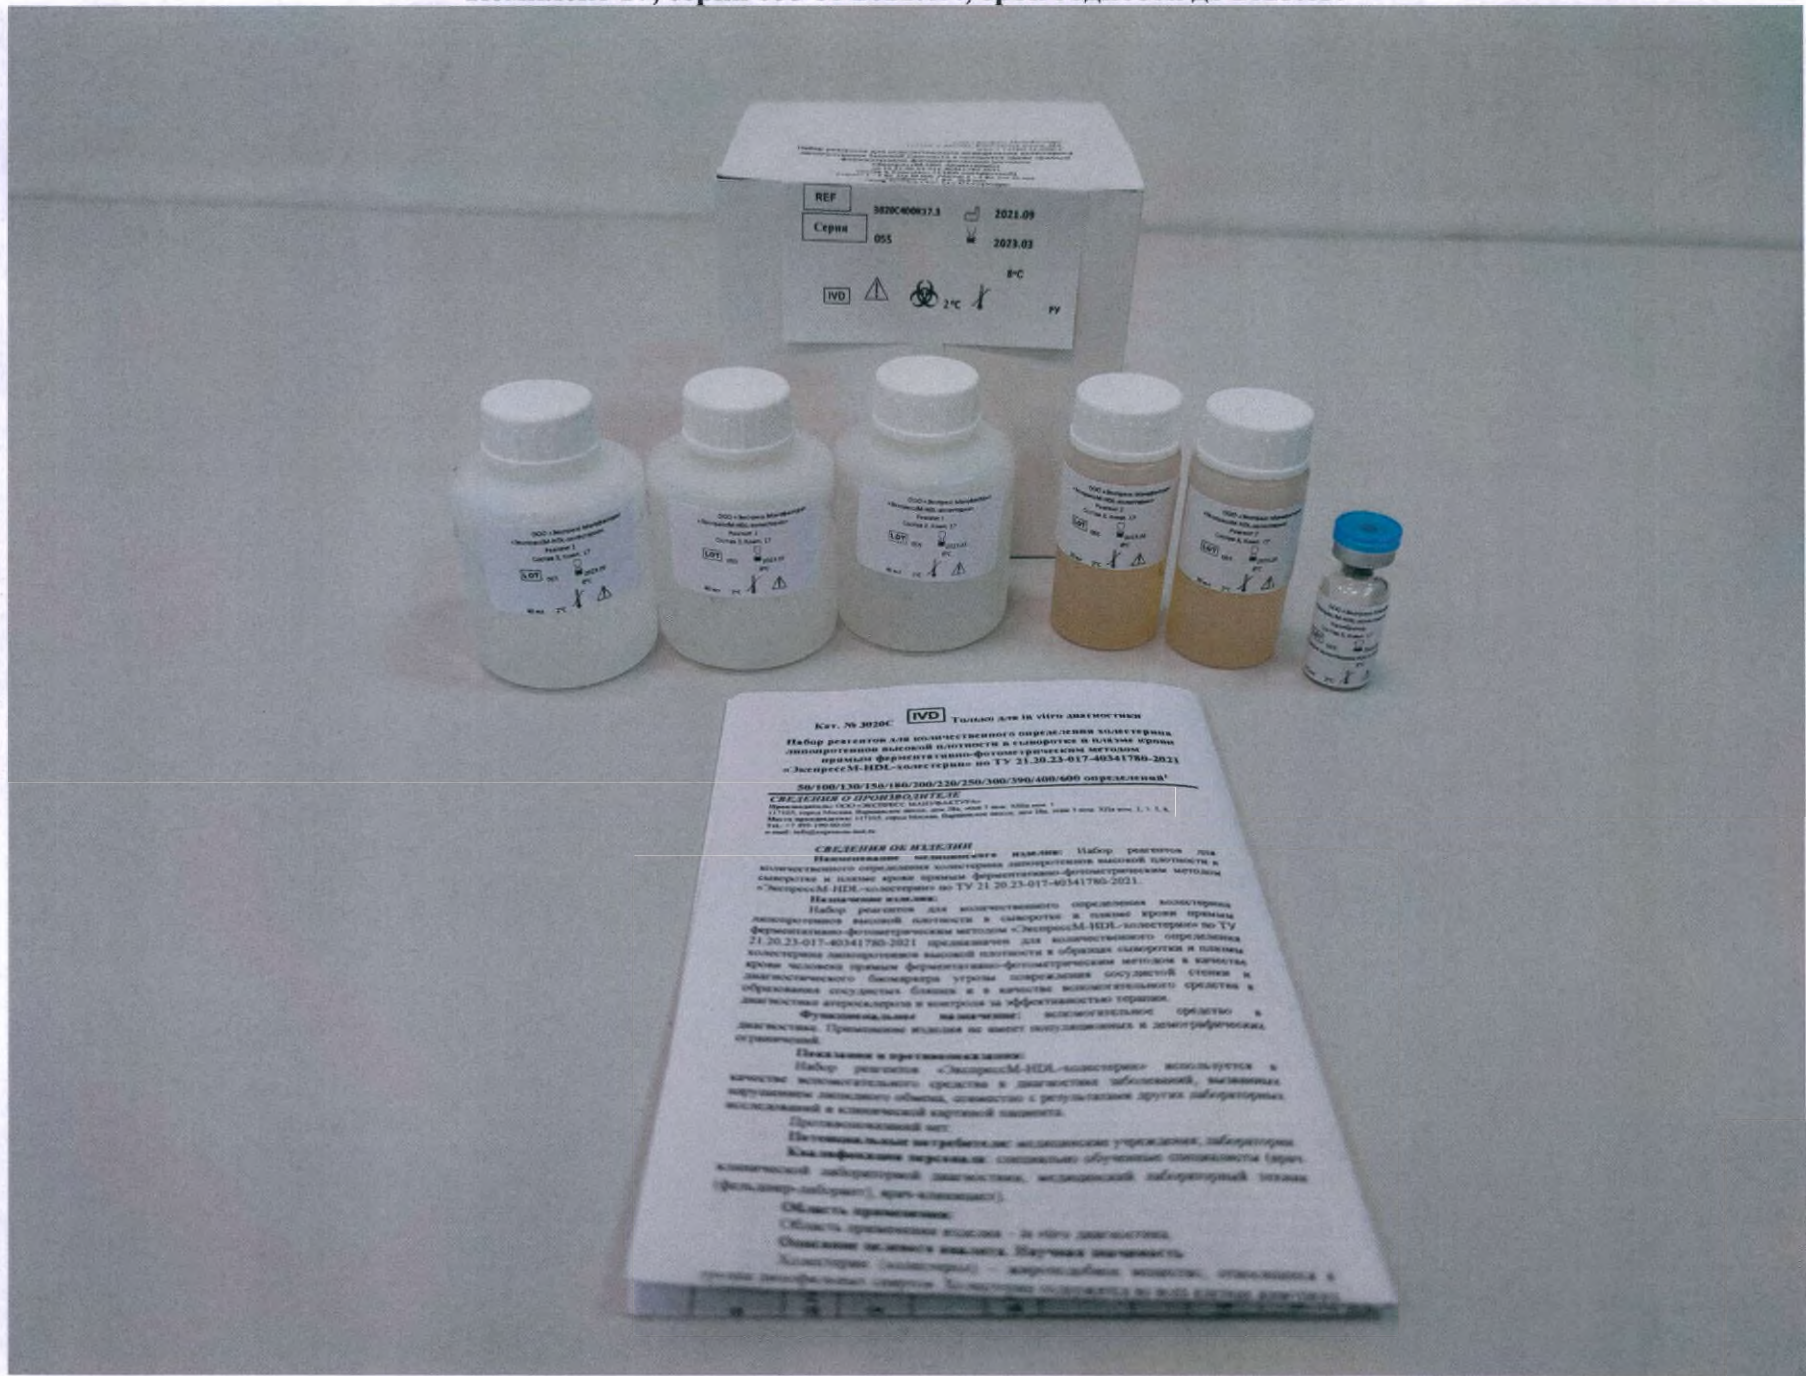

ООО «Центр тестирования»
117115, г. Москва, Вешняковское шоссе, 28А
тел.: +7 (495) 19 3000 5

**Набор реактивов для количественного определения концентрации
микроэлементов высшей чистоты в сыпучих порошках прямым
фотометрическим методом**

в соответствии с ГОСТ 17007-2021
в соответствии с ГОСТ 17007-2021
Согласно ГОСТ 17007-2021
Реактив 1 – 1 г (содержит 10 мг), Реактив 2 – 1 г (содержит 10 мг),
стандартный – 1 г (содержит 10 мг), Реактив 3 – 1 г (содержит 10 мг).



Кат. № 2008 **ND** Только для в/в использования

**Набор реактивов для количественного определения содержания
микроэлементов высшей чистоты в сыпучих порошках прямым
фотометрическим методом**


в соответствии с ГОСТ 17007-2021
в соответствии с ГОСТ 17007-2021
Согласно ГОСТ 17007-2021
Реактив 1 – 1 г (содержит 10 мг), Реактив 2 – 1 г (содержит 10 мг),
стандартный – 1 г (содержит 10 мг), Реактив 3 – 1 г (содержит 10 мг).

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЪЕДИН


Микроэлементы – это химические элементы, которые входят в состав биологических организмов в очень малых количествах. Они играют важную роль в жизнедеятельности организма. Микроэлементы делятся на две группы: макроэлементы и микроэлементы. Макроэлементы входят в состав организма в больших количествах, а микроэлементы – в очень малых. Микроэлементы необходимы для нормального функционирования организма. Недостаток или избыток микроэлементов может привести к различным заболеваниям. Поэтому очень важно следить за содержанием микроэлементов в организме. Для этого существуют различные методы, в том числе и фотометрический метод, который описан в данном наборе реактивов.


**Набор реактивов для количественного определения содержания
микроэлементов высшей чистоты в сыпучих порошках прямым
фотометрическим методом**

в соответствии с ГОСТ 17007-2021
в соответствии с ГОСТ 17007-2021
Согласно ГОСТ 17007-2021
Реактив 1 – 1 г (содержит 10 мг), Реактив 2 – 1 г (содержит 10 мг),
стандартный – 1 г (содержит 10 мг), Реактив 3 – 1 г (содержит 10 мг).



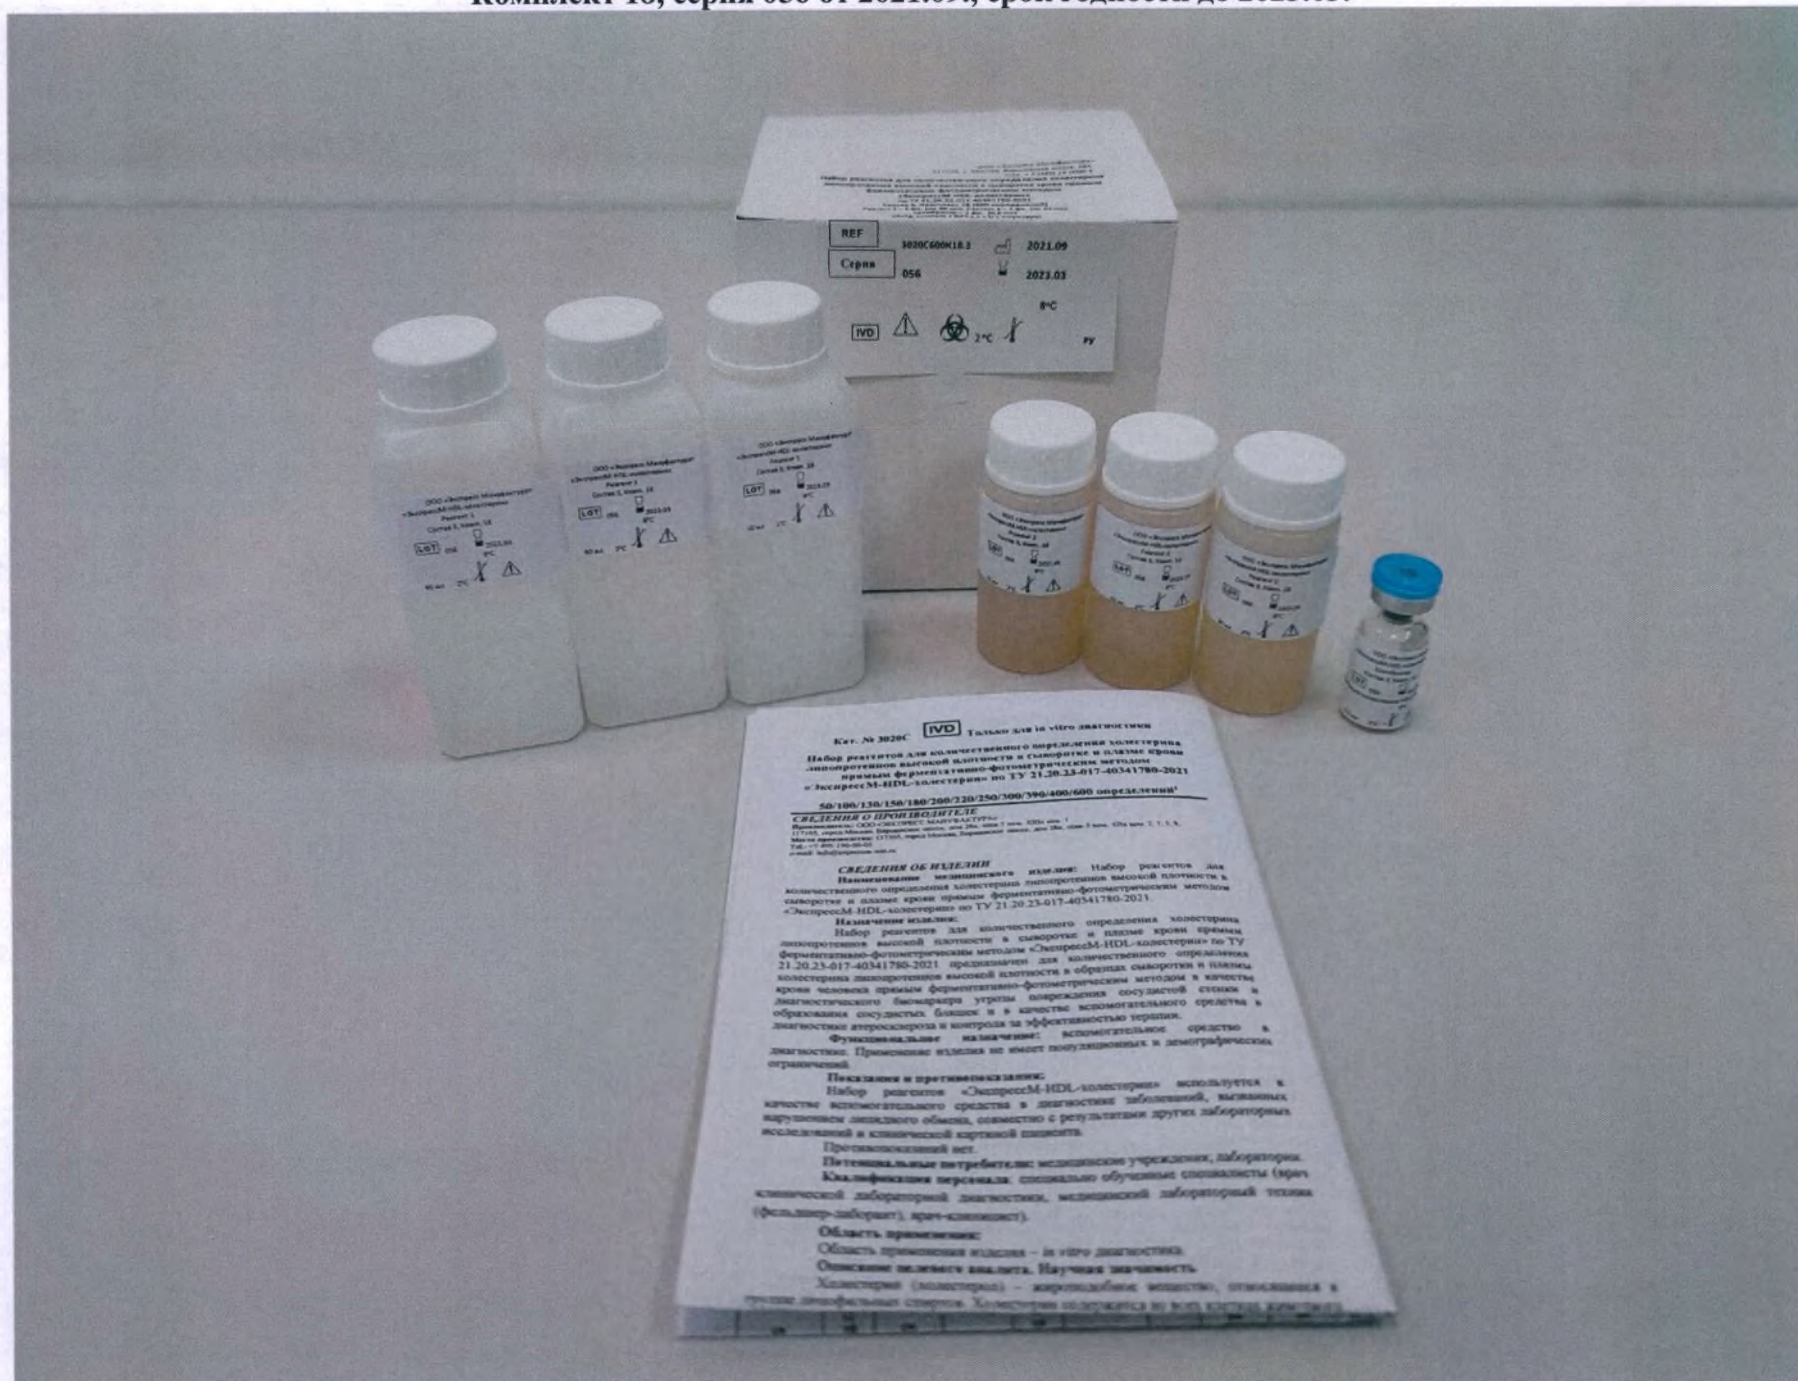




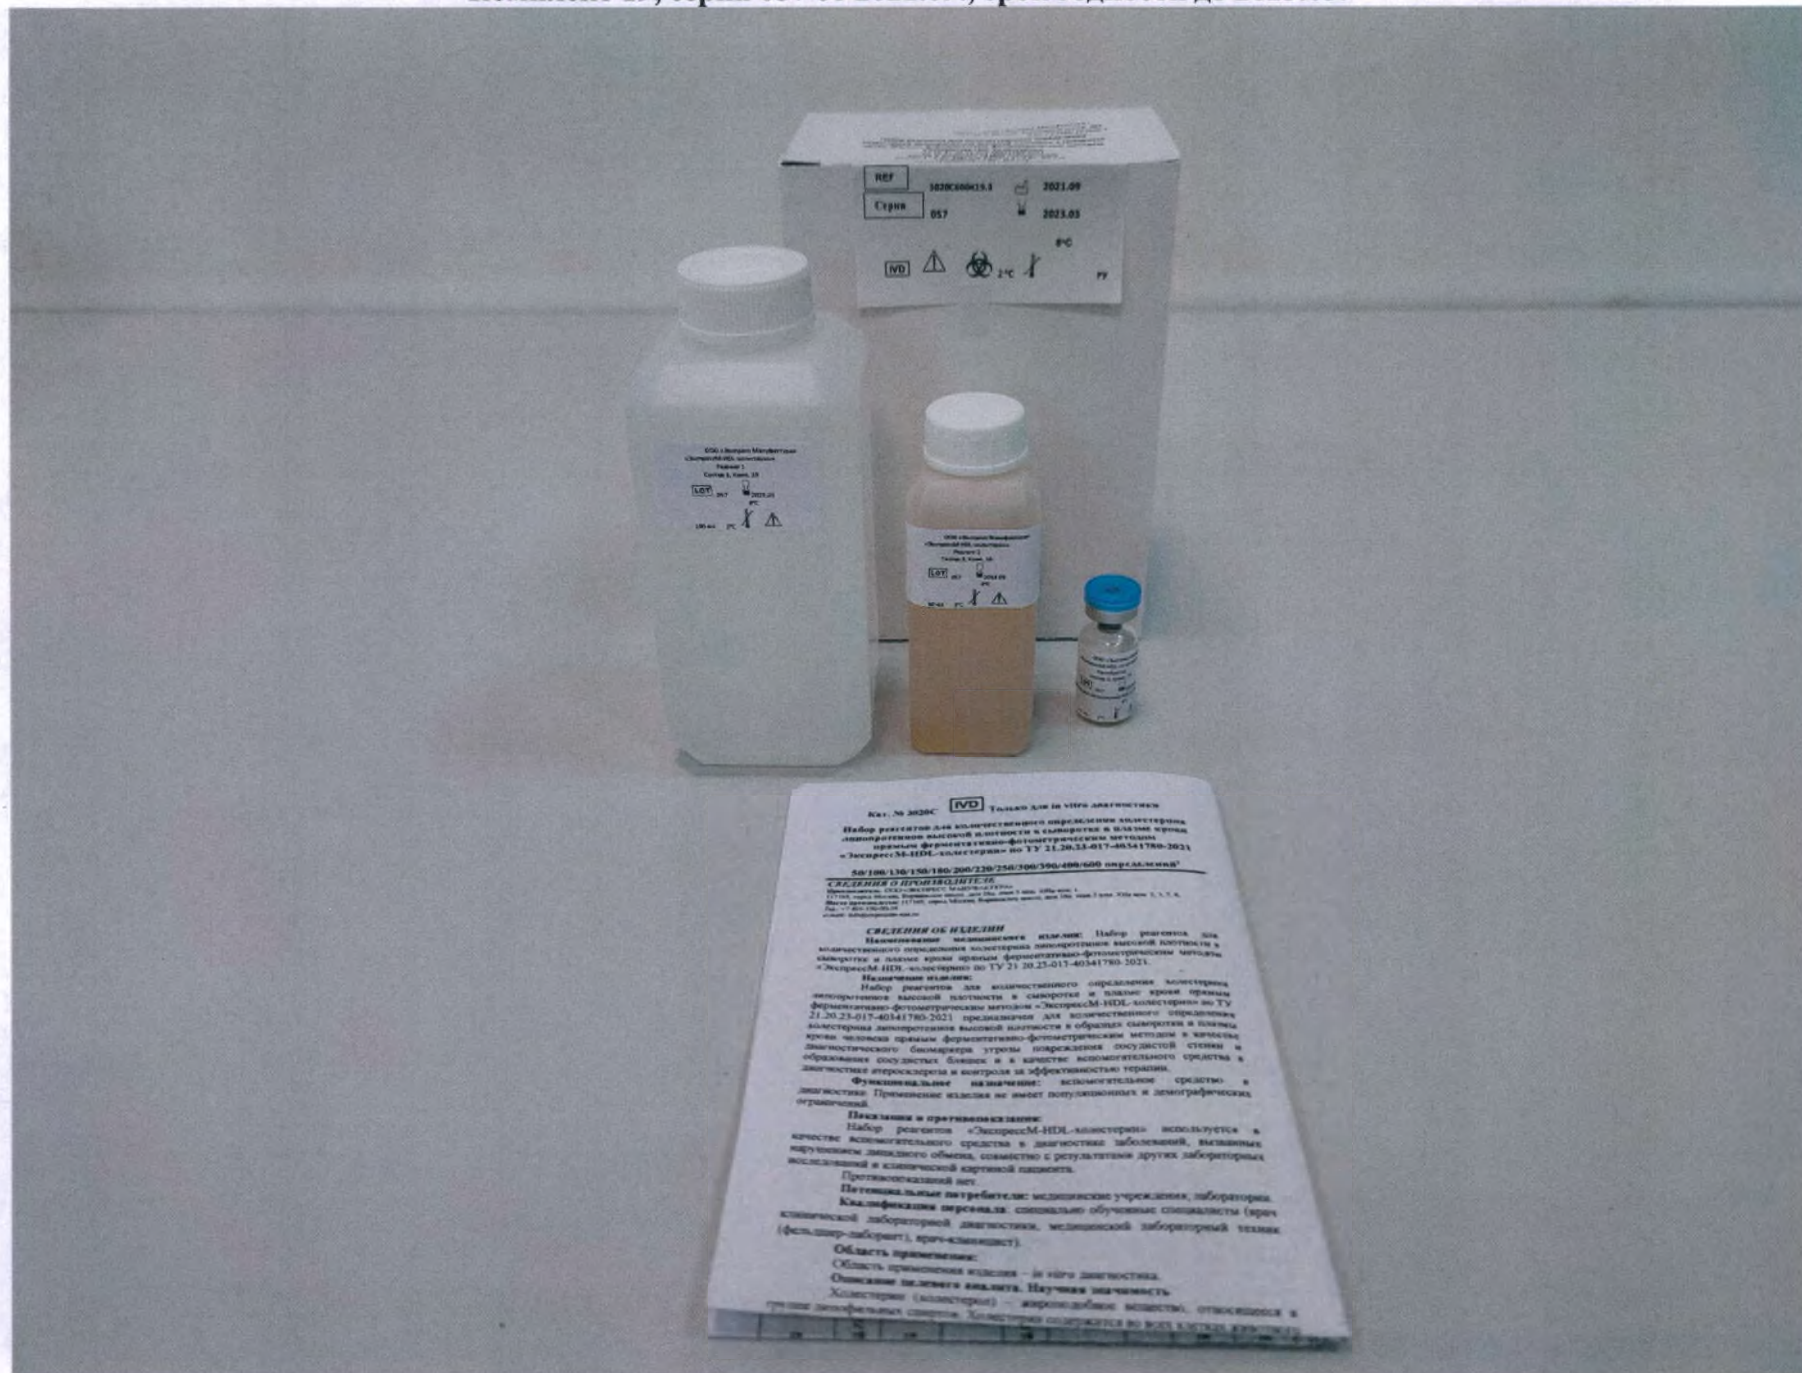

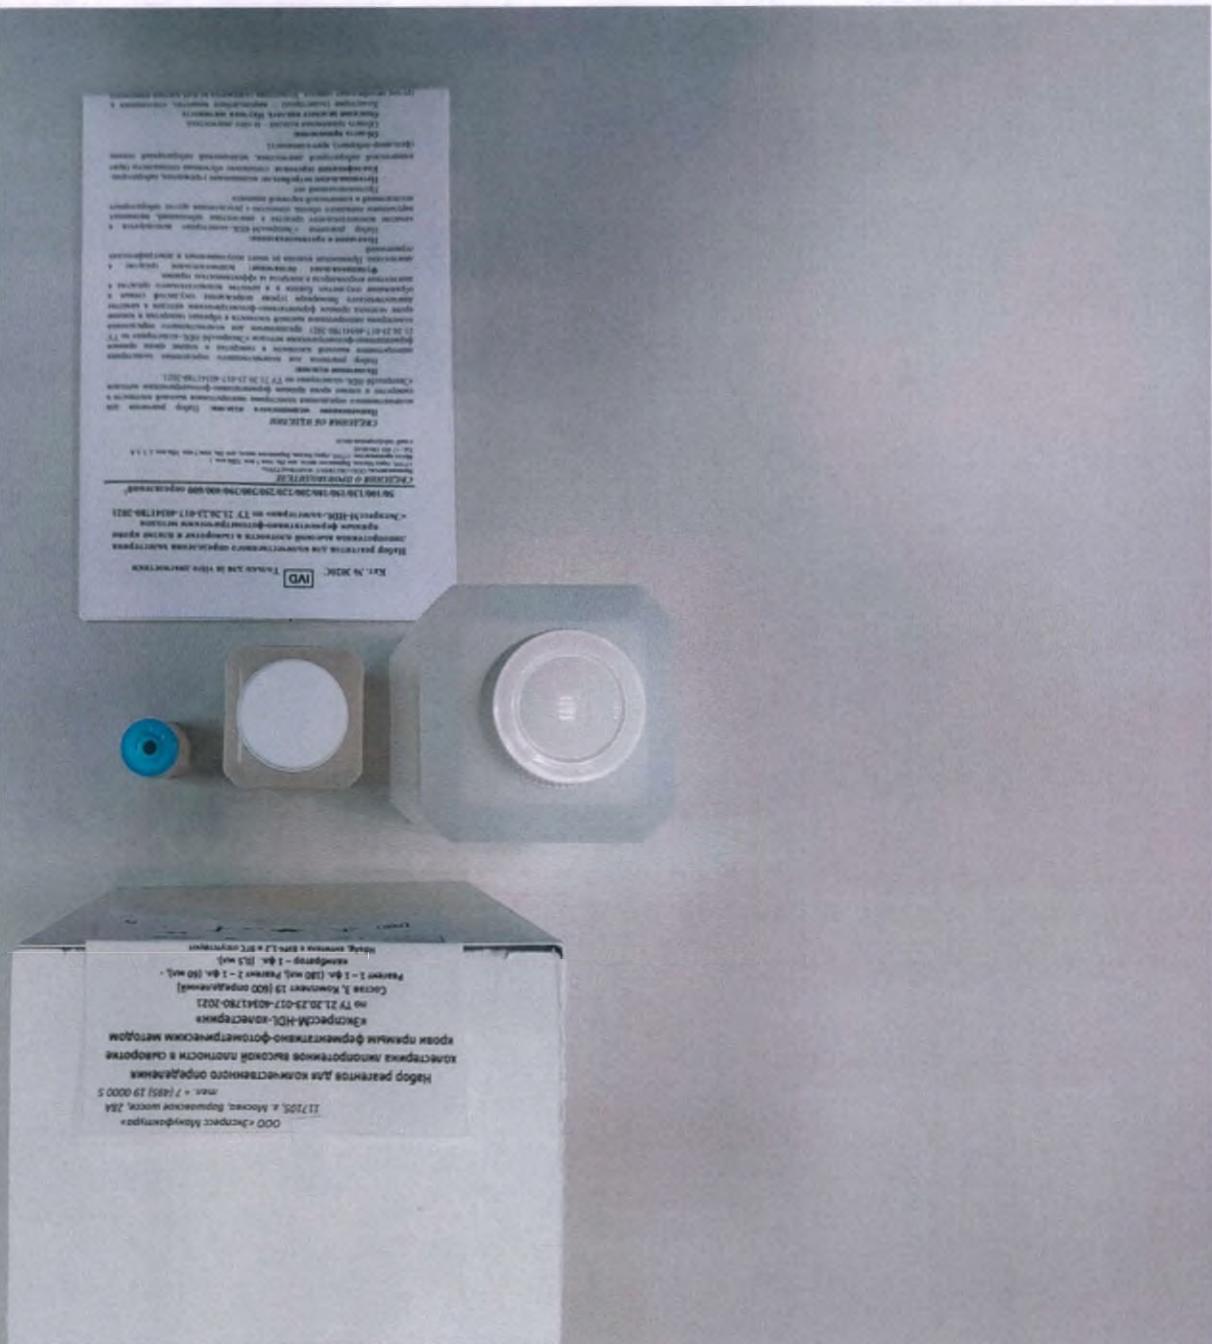





1. Реагент 1

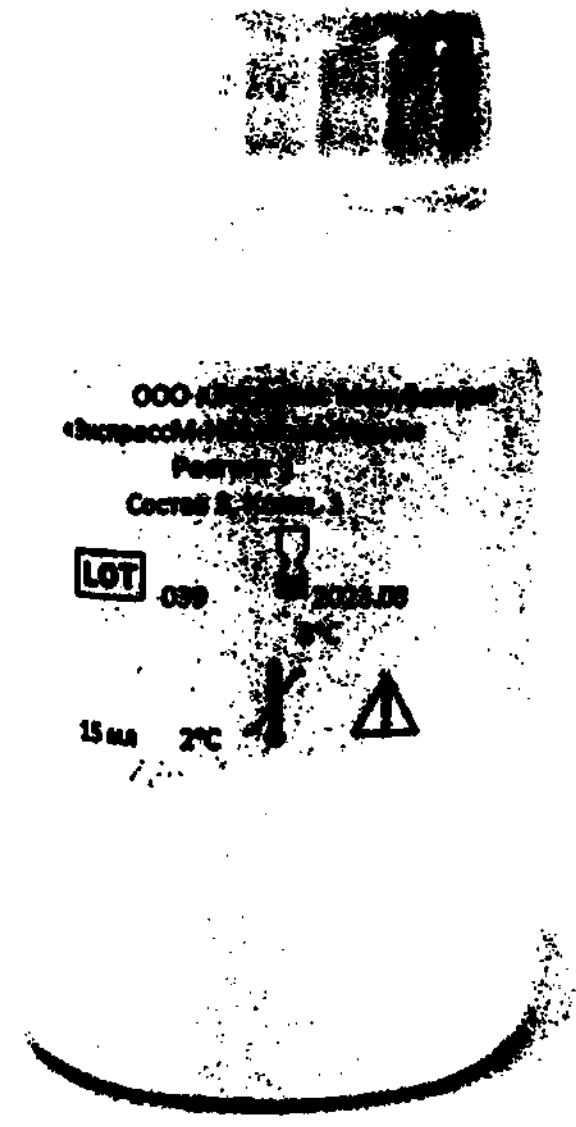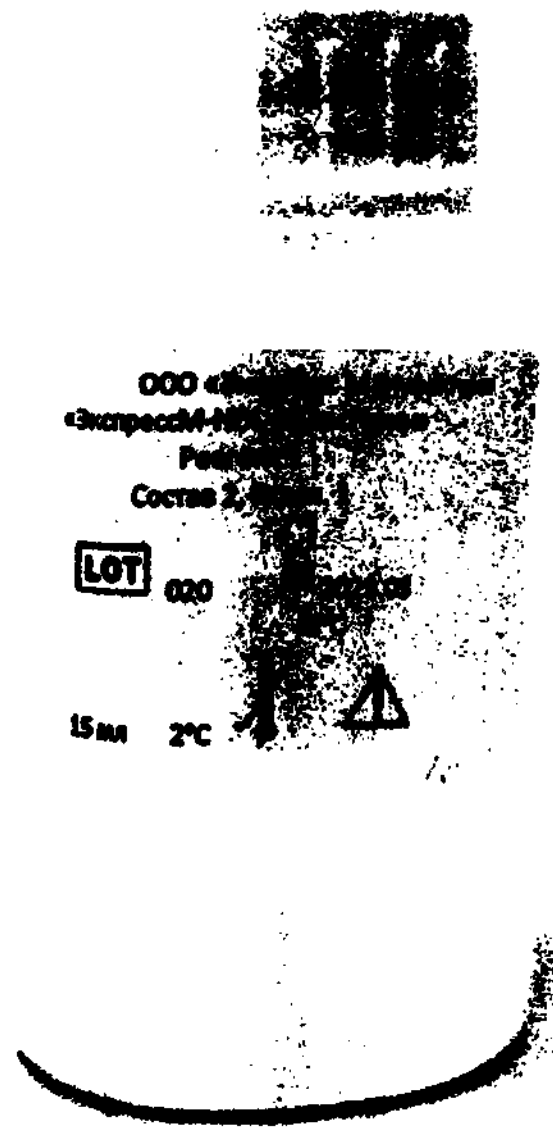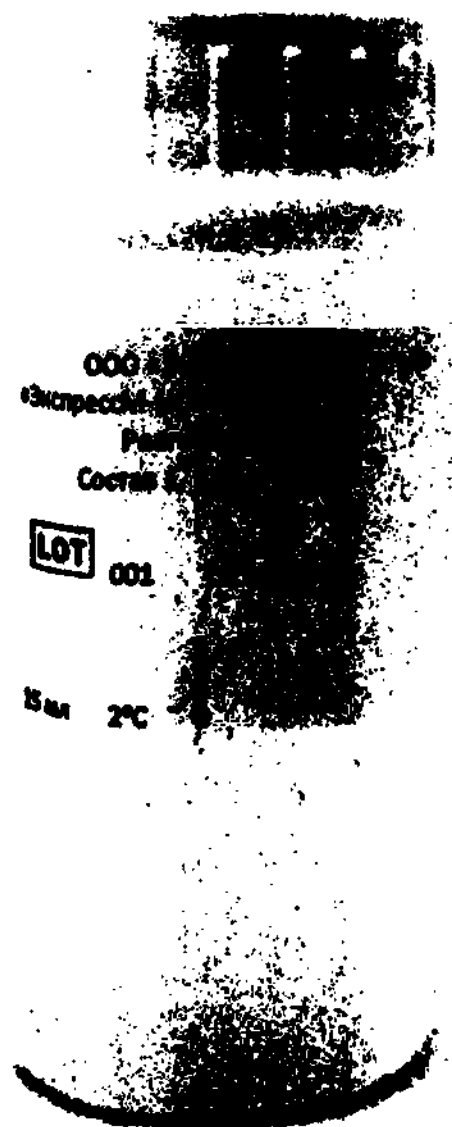



2. Реагент 2





3. Калибратор

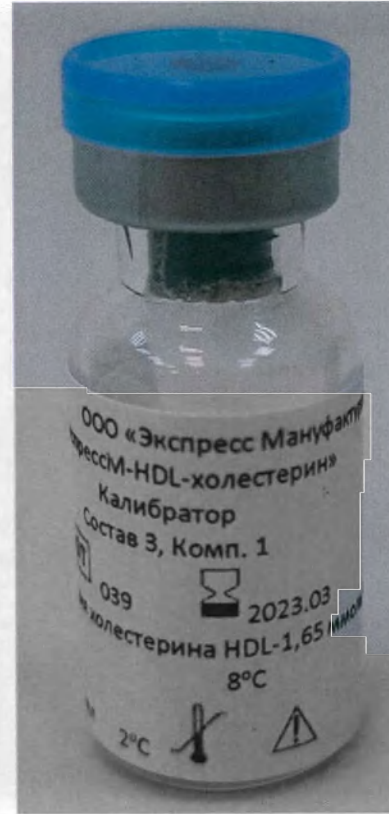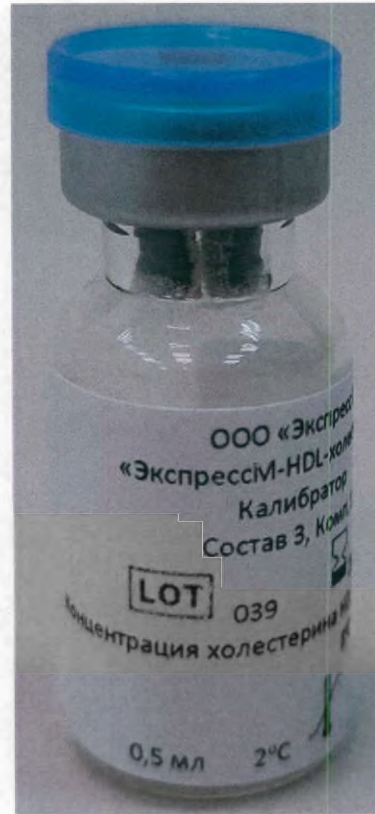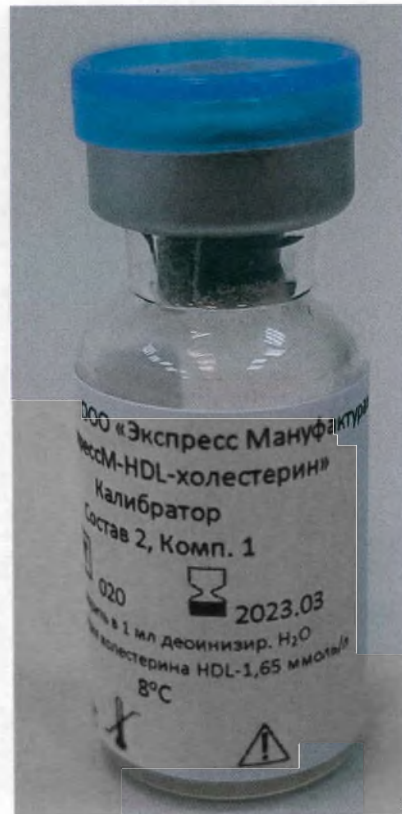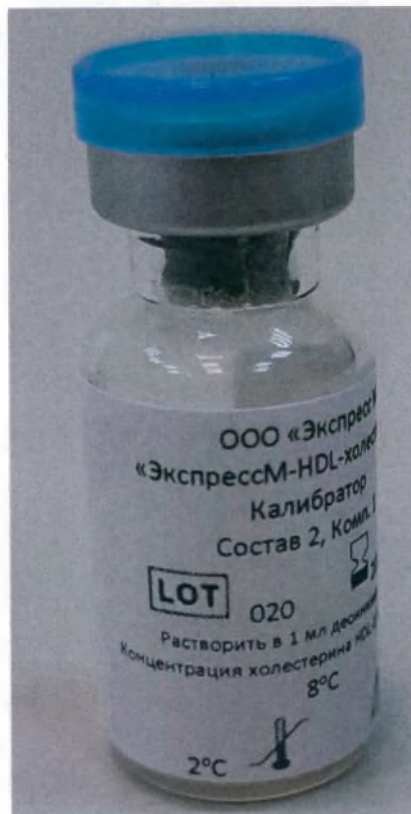

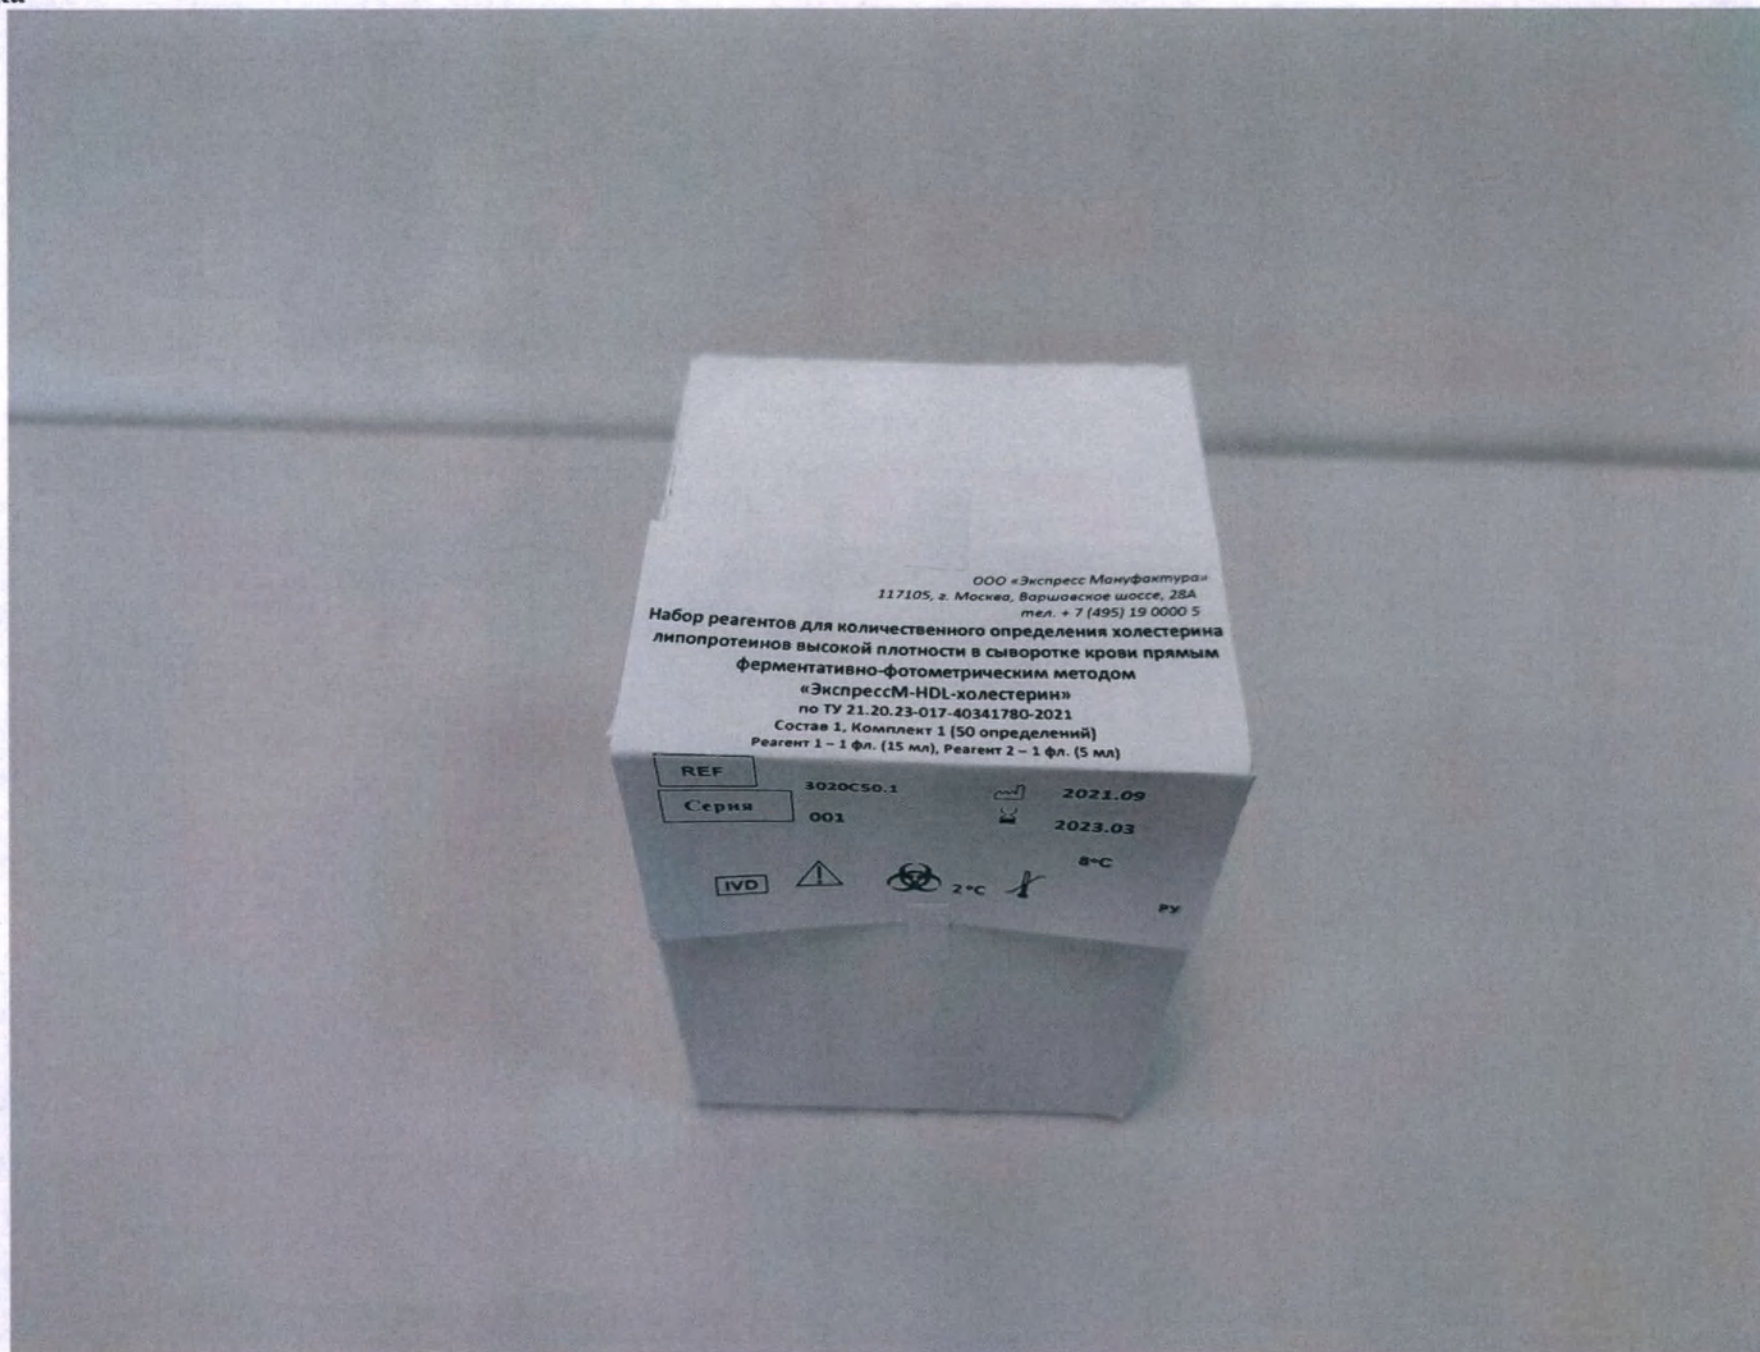

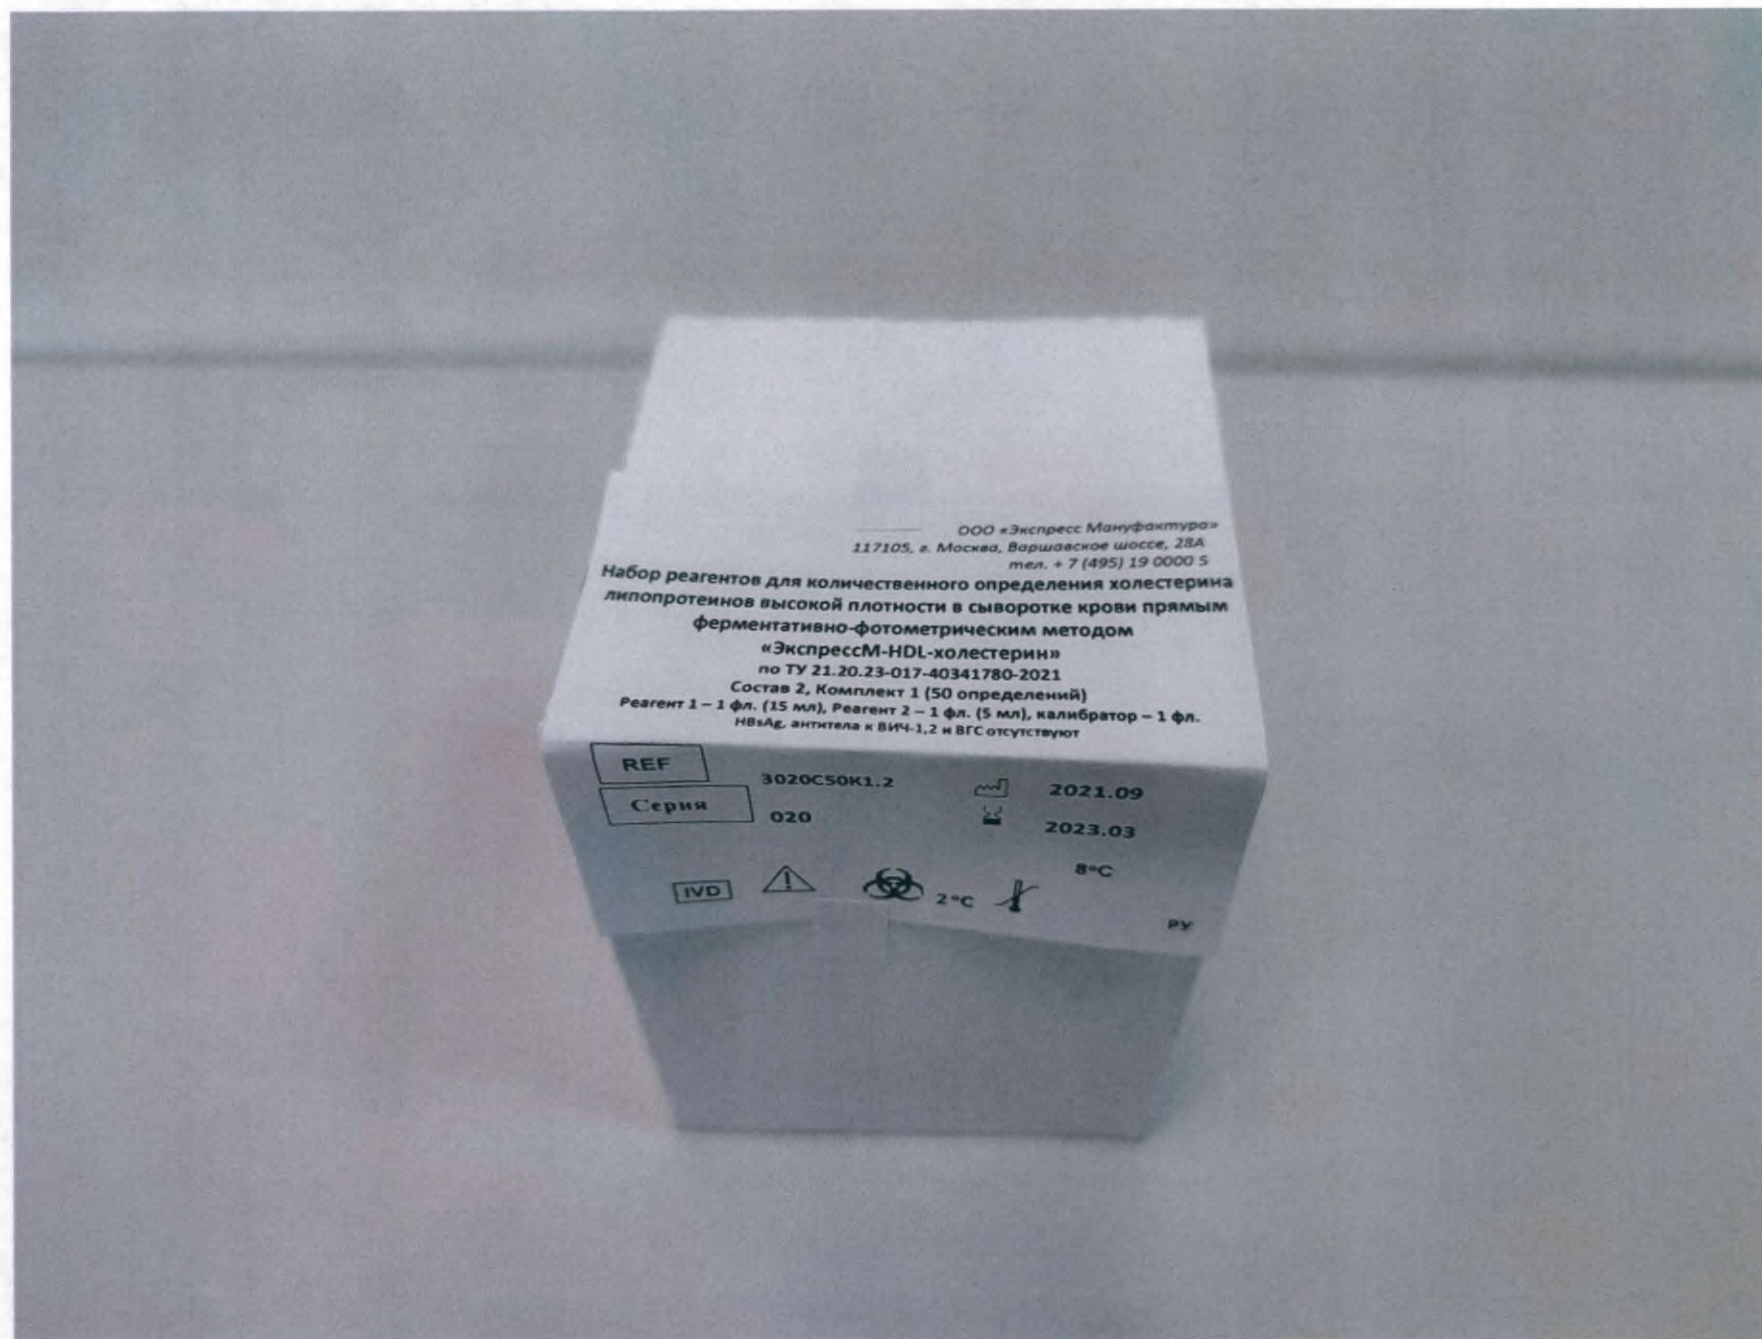

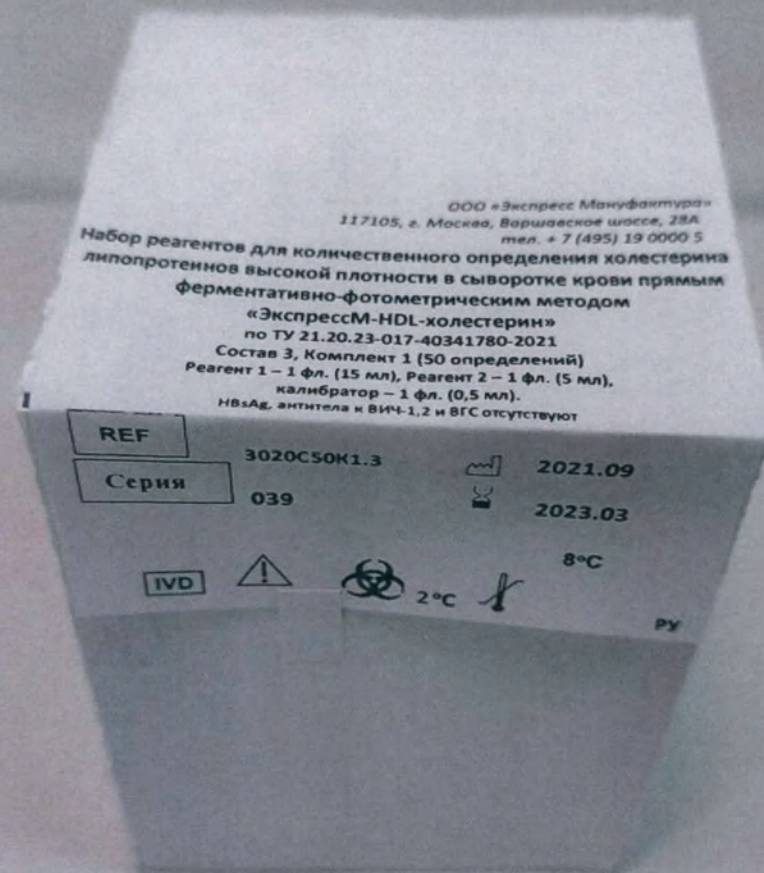

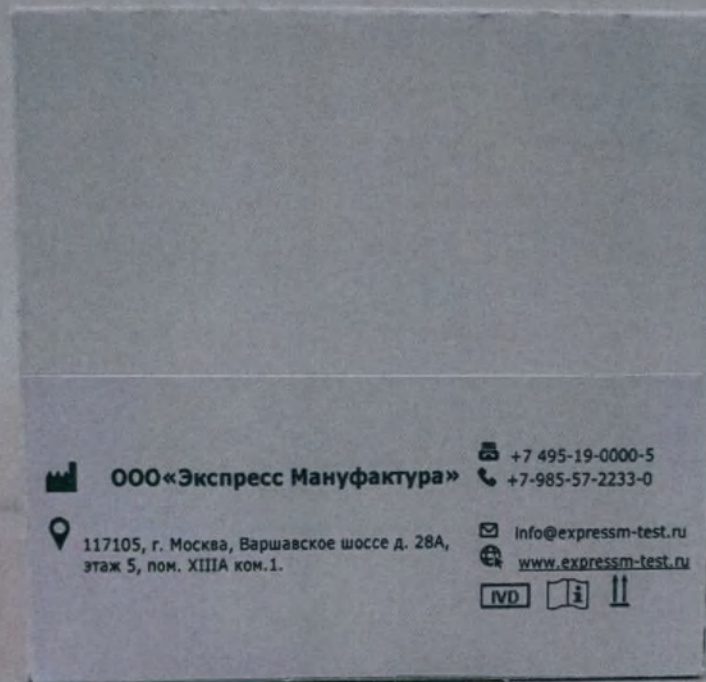

Генеральный директор ООО «Экспресс Мануфактура»



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

121 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И.В.

« 10 » 09

