


Фотографические изображения общего вида
Набор реагентов для иммунохроматографического определения прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови человека «ЭкспрессМ-ПКТ»
Комплект 1, серия 001 от 2021.06., срок годности до 2023.08.



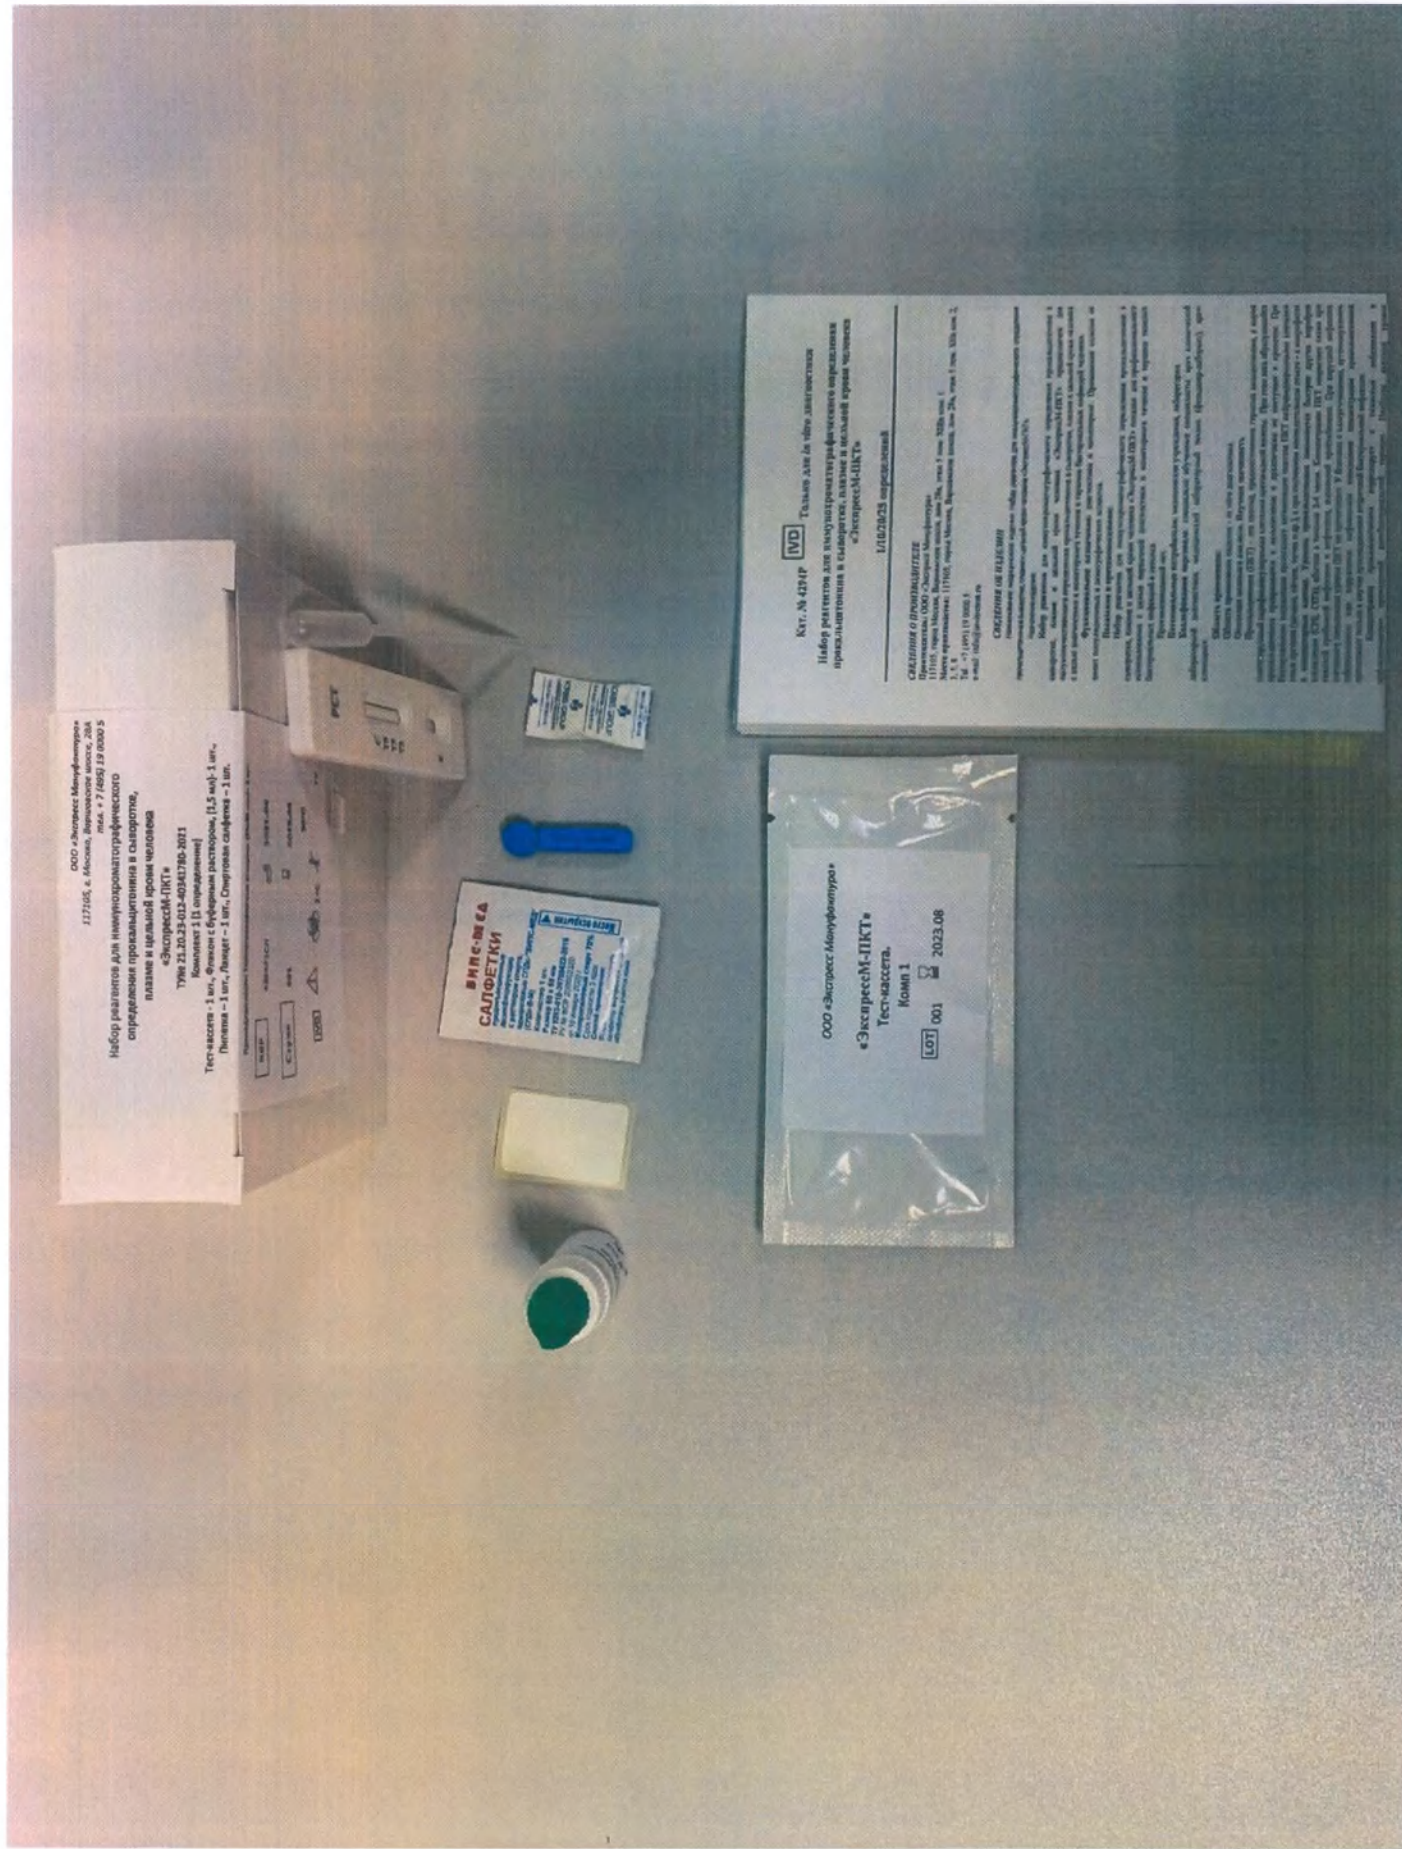

ООО «Экспресс МедиФабрика»
127168, г. Москва, м.м.п. «7/888» 18 0000 5
Набор реагентов для иммунохроматографического
определения провирусных и сывороточных,
плазменных и цельных ионов человека
«ЭкспрессМ-ПКТ»
Тираж 21.20.29.012.4014170.2021
Выпускает 1 шт. (содержит)
Тест-кассета - 1 шт., Формант в буферном растворе (1,5 мл) - 1 шт.,
Платина - 1 шт., Липид - 1 шт., Стерильная салфетка - 1 шт.

ВИР-БЕГА
САЛФЕТКИ
«ЭкспрессМ-ПКТ»
Тест-кассета
Комп 1
LOT 001 2023.08


Кит. № 421P IVD Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для иммунохроматографического определения
прямых антигенов в сыворотке, плазме и цельных ионах человека
«ЭкспрессМ-ПКТ»
11021023 определяющий




СЕРТИФИКАТ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
111111, серия Москва, Выпускной номер 1, дата 1 мая 2023 года
1. Наименование: 111111, серия Москва, Выпускной номер 1, дата 1 мая 2023 года
2. Тип: «111111» (111111)
3. Вид: (111111) (111111)


СЕРТИФИКАТ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Наименование: 111111, серия Москва, Выпускной номер 1, дата 1 мая 2023 года
1. Наименование: 111111, серия Москва, Выпускной номер 1, дата 1 мая 2023 года
2. Тип: «111111» (111111)
3. Вид: (111111) (111111)

СЕРТИФИКАТ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Наименование: 111111, серия Москва, Выпускной номер 1, дата 1 мая 2023 года
1. Наименование: 111111, серия Москва, Выпускной номер 1, дата 1 мая 2023 года
2. Тип: «111111» (111111)
3. Вид: (111111) (111111)




ООО «Экспресс МедиФабрика»
«ЭкспрессМ-ПКТ»
Тест-кассета
Комп 1
LOT 001 2023.08

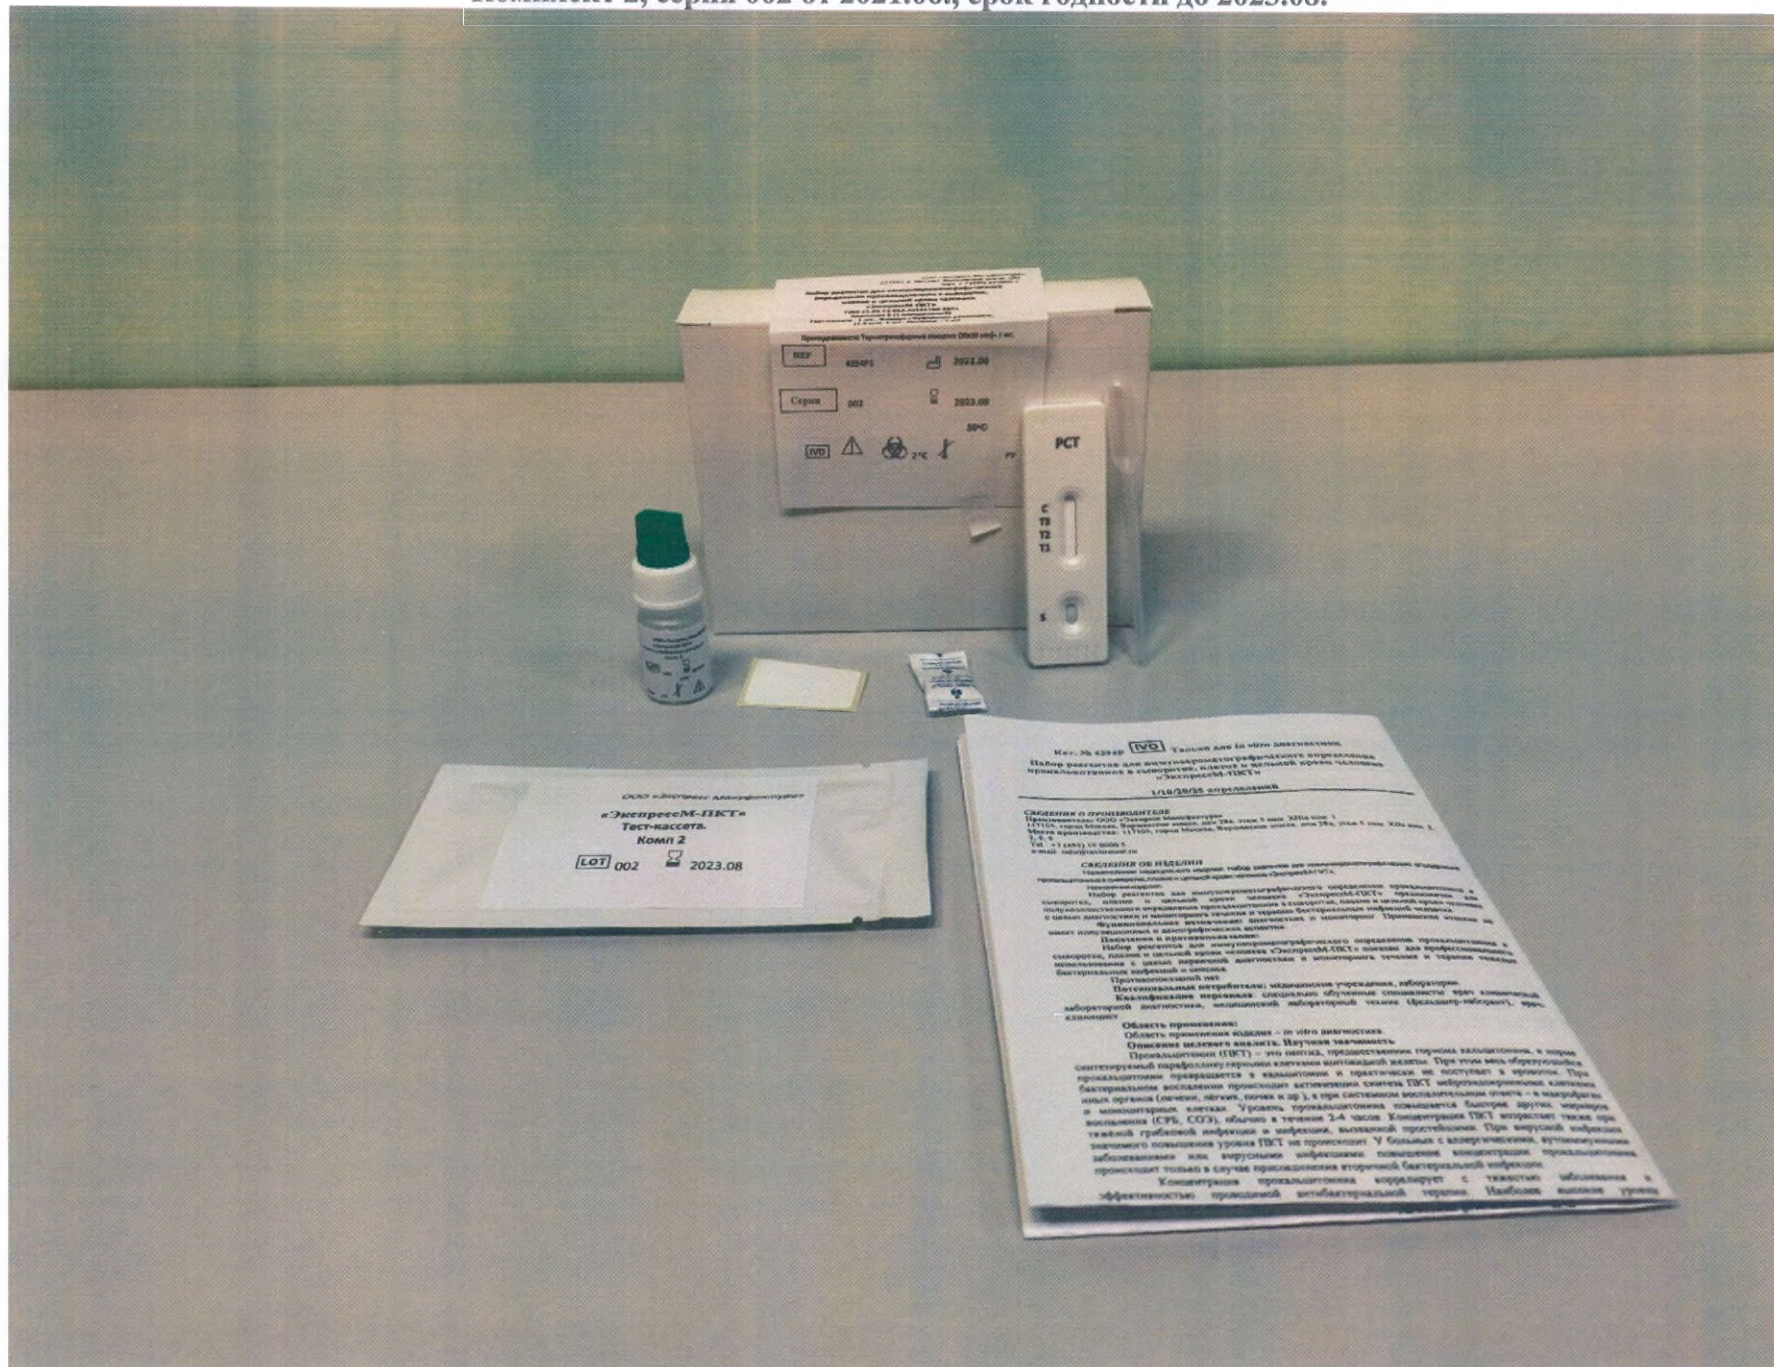

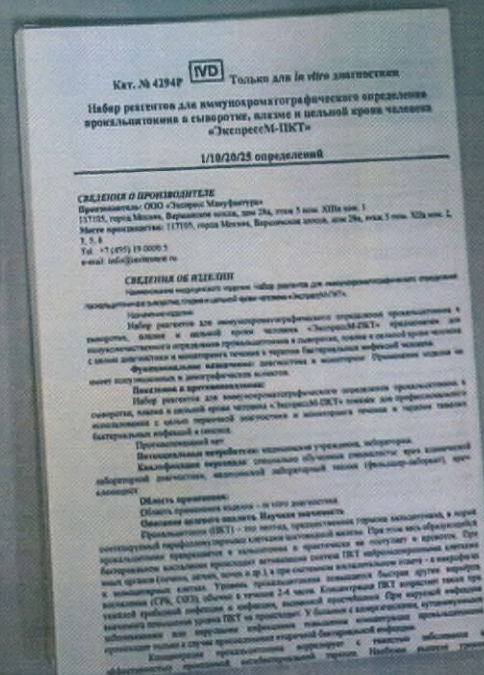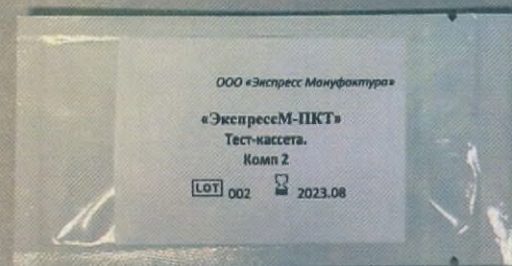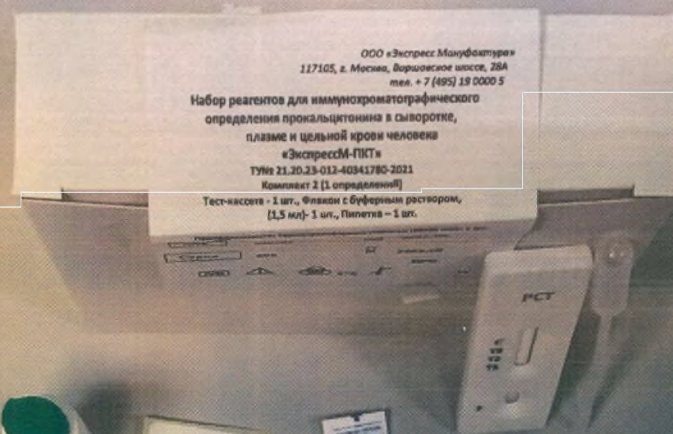

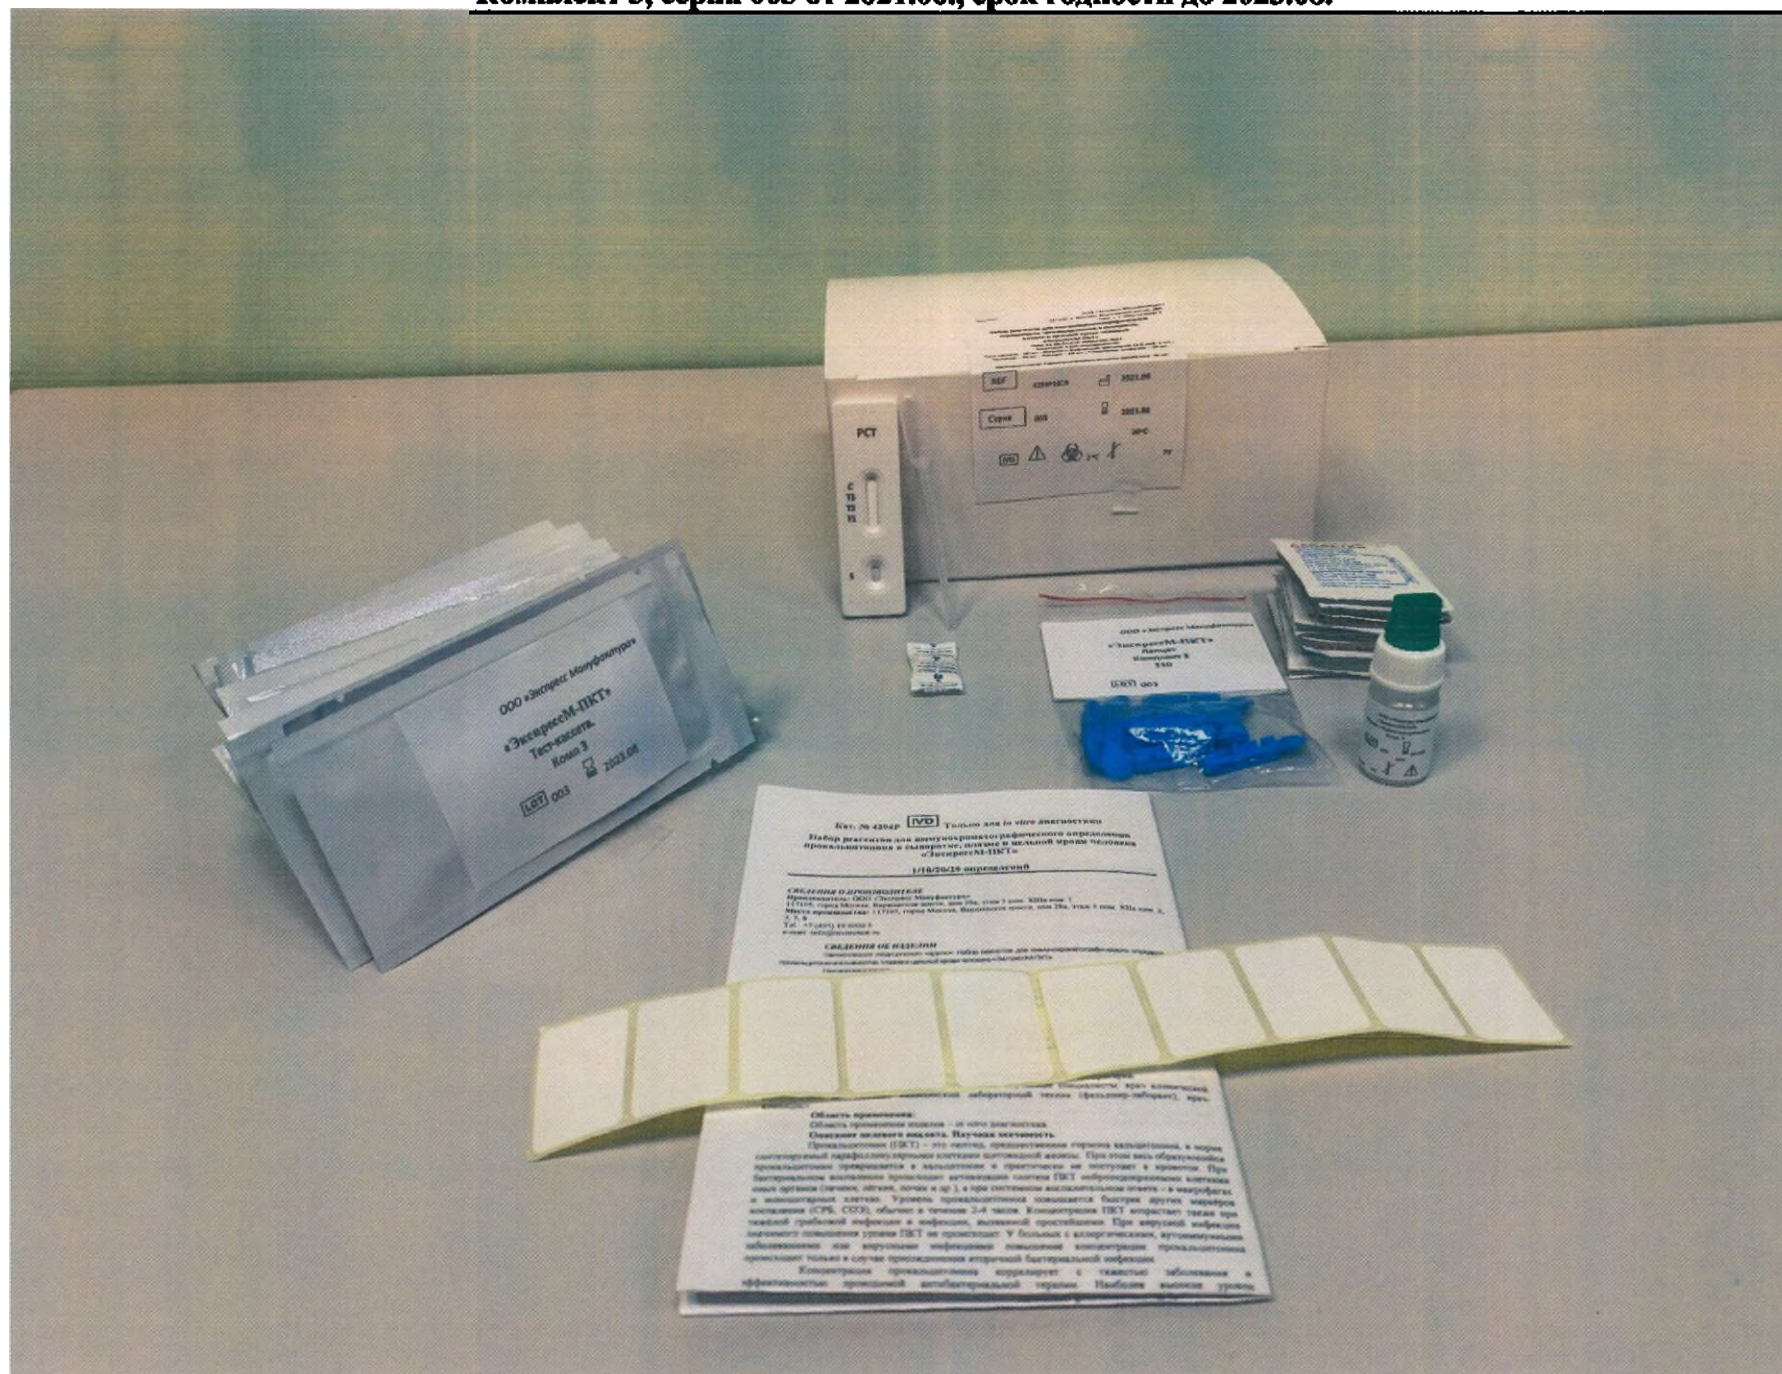





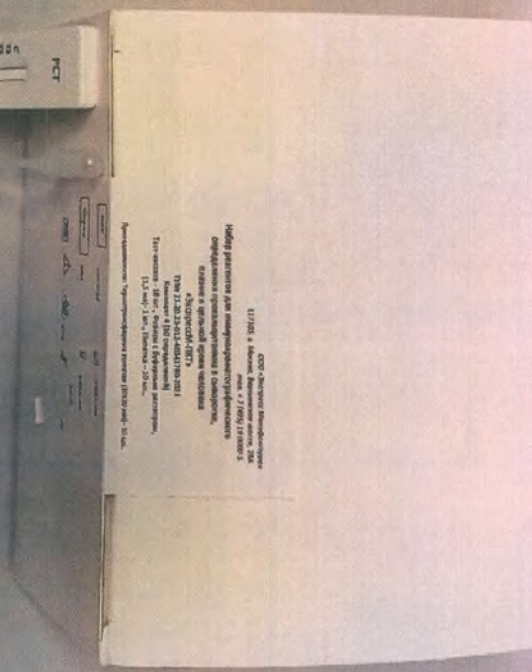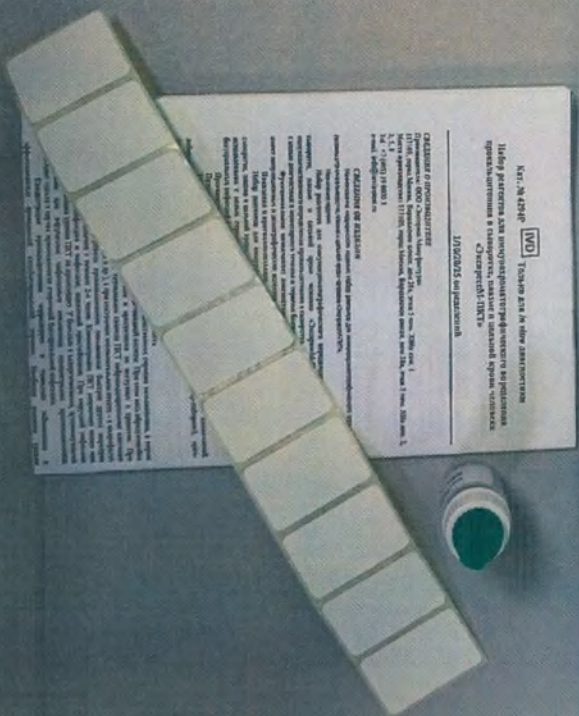







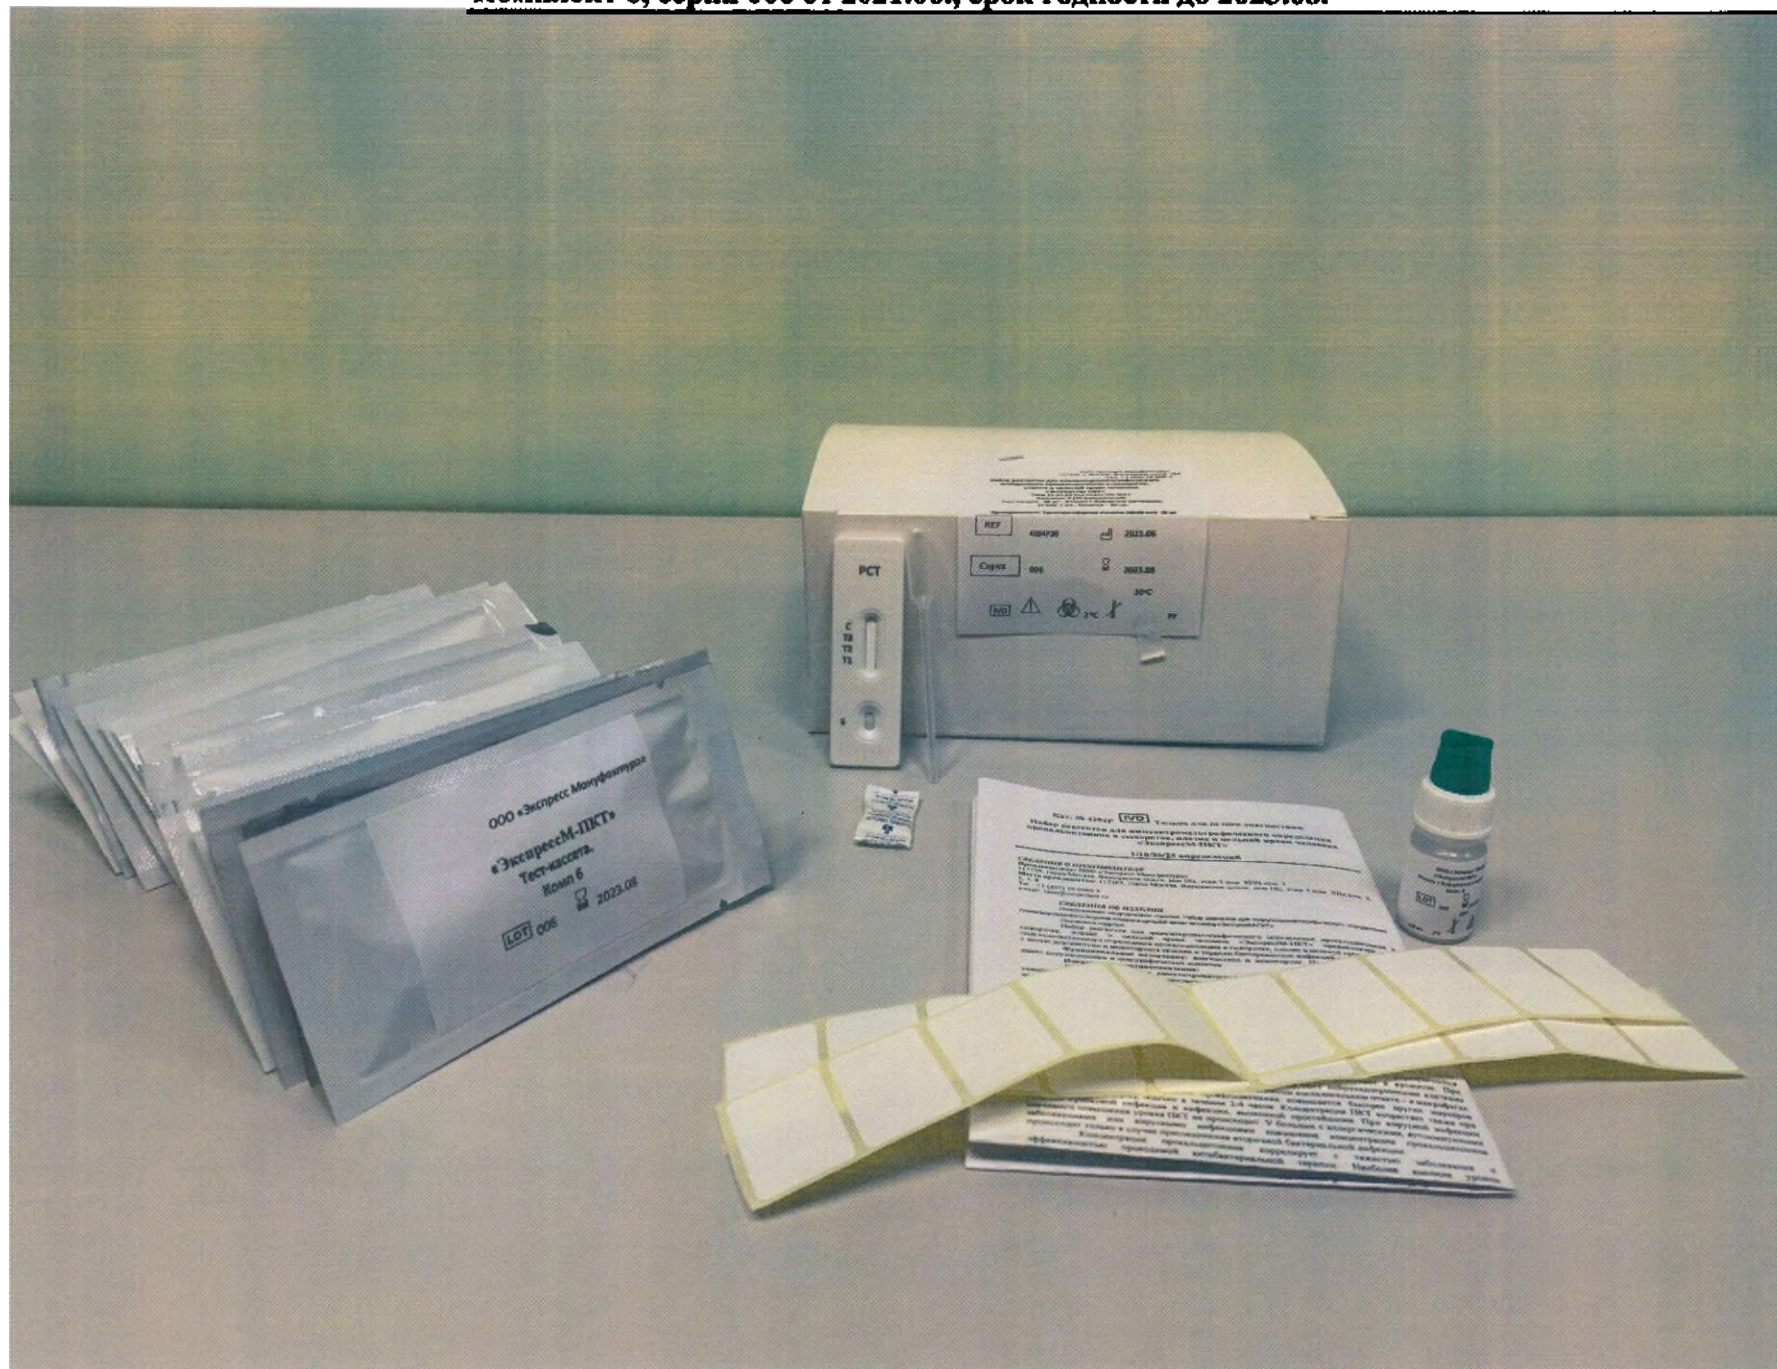


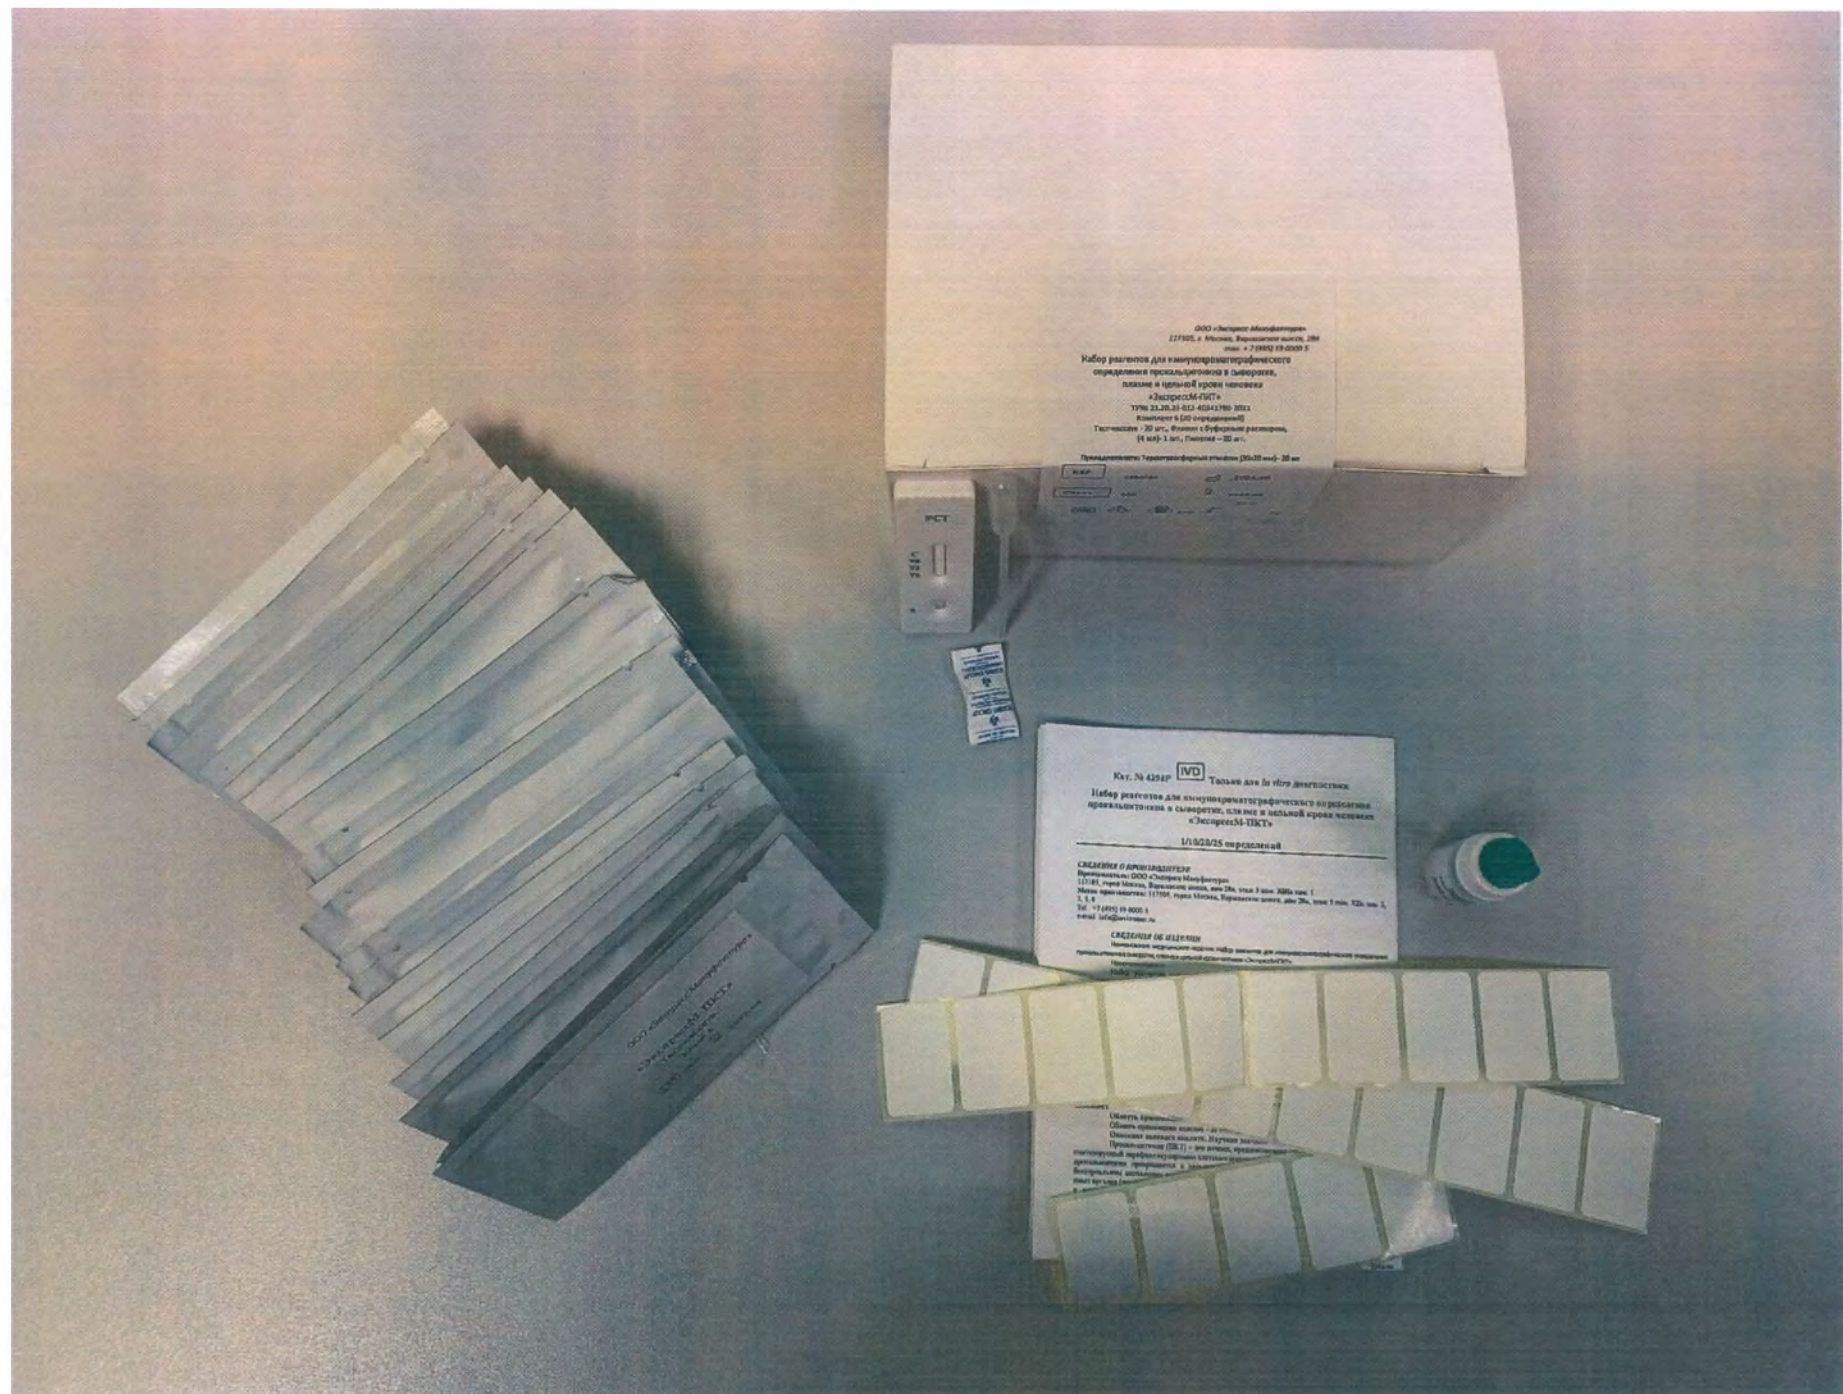


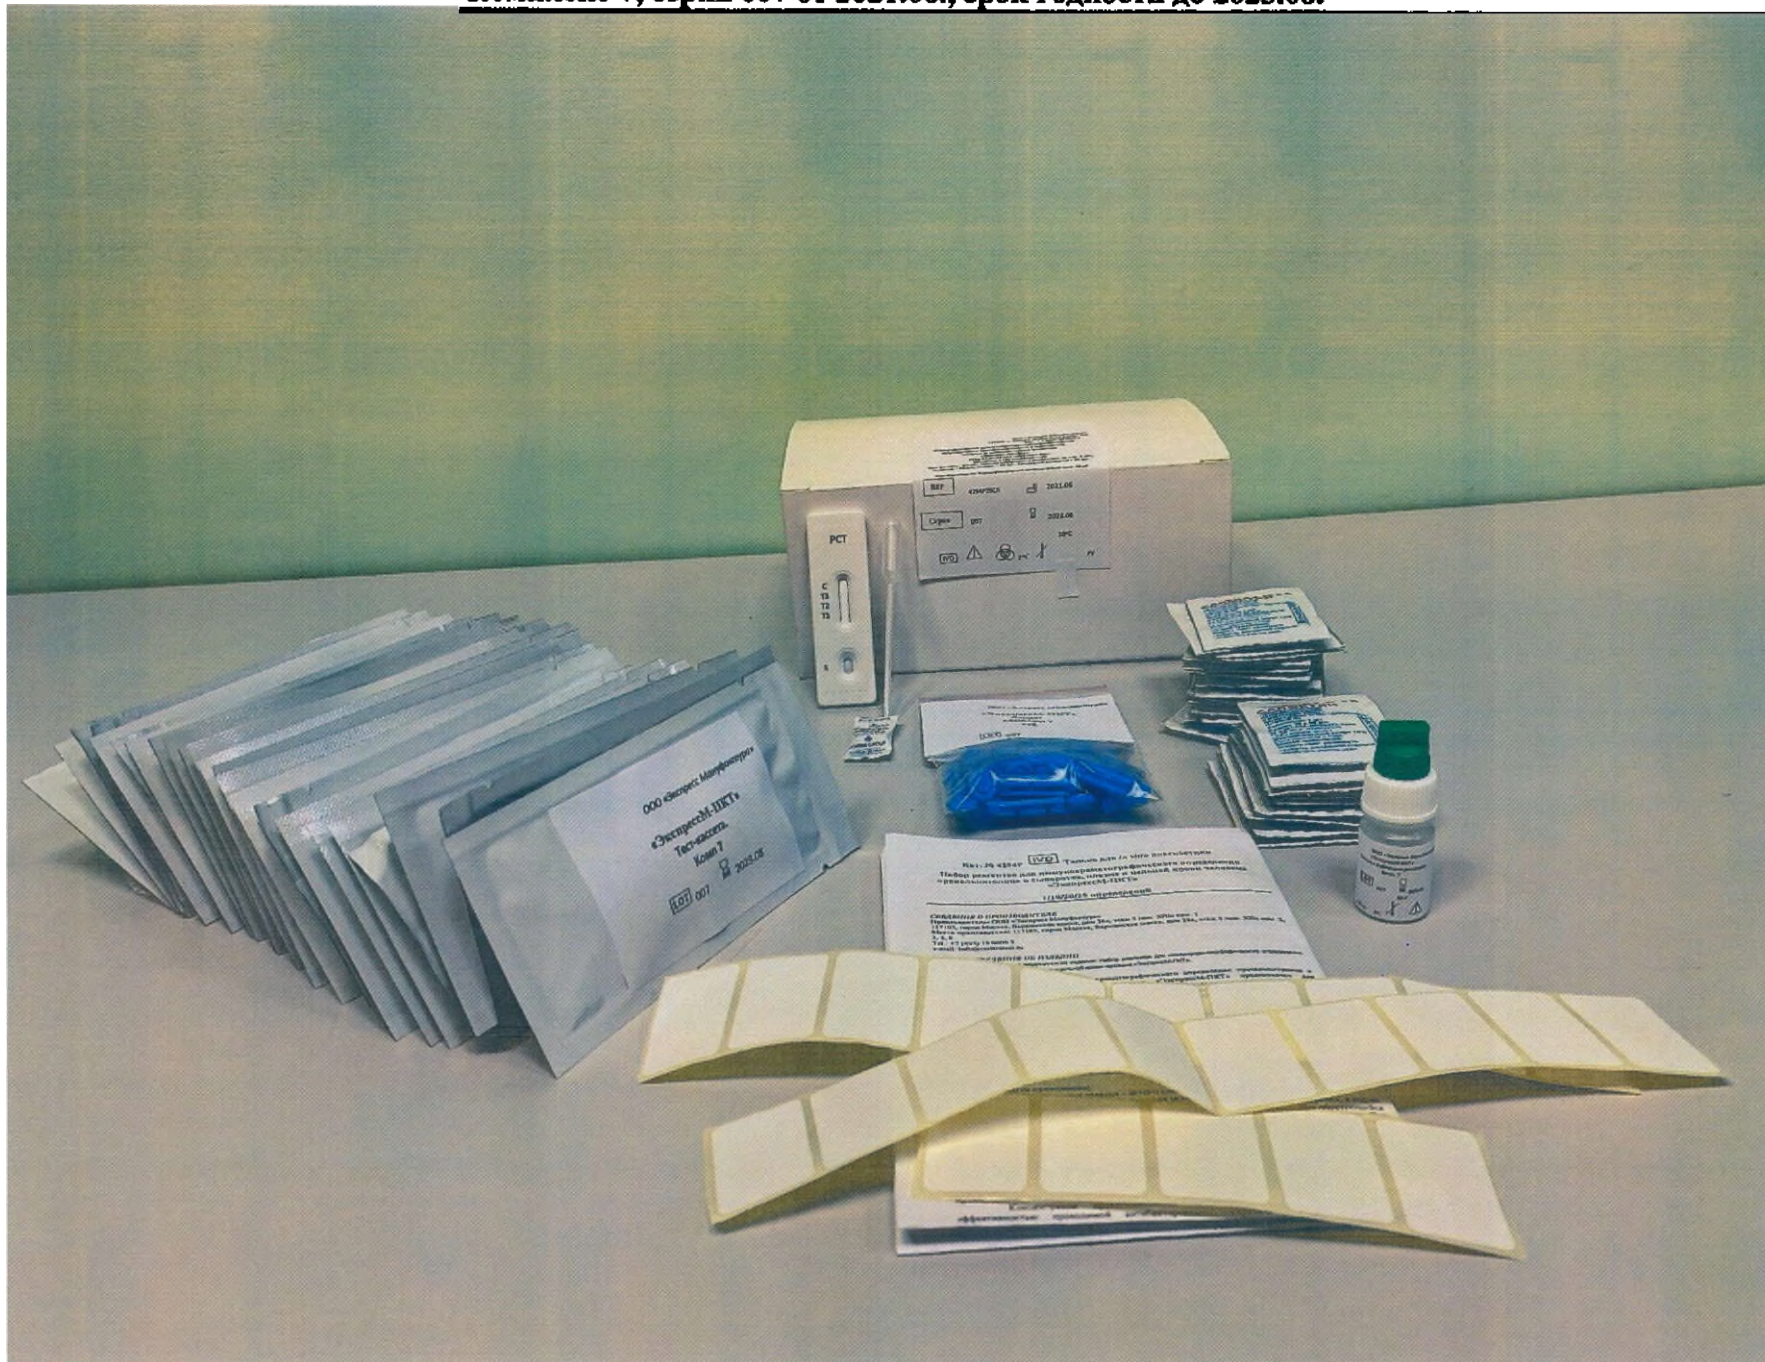





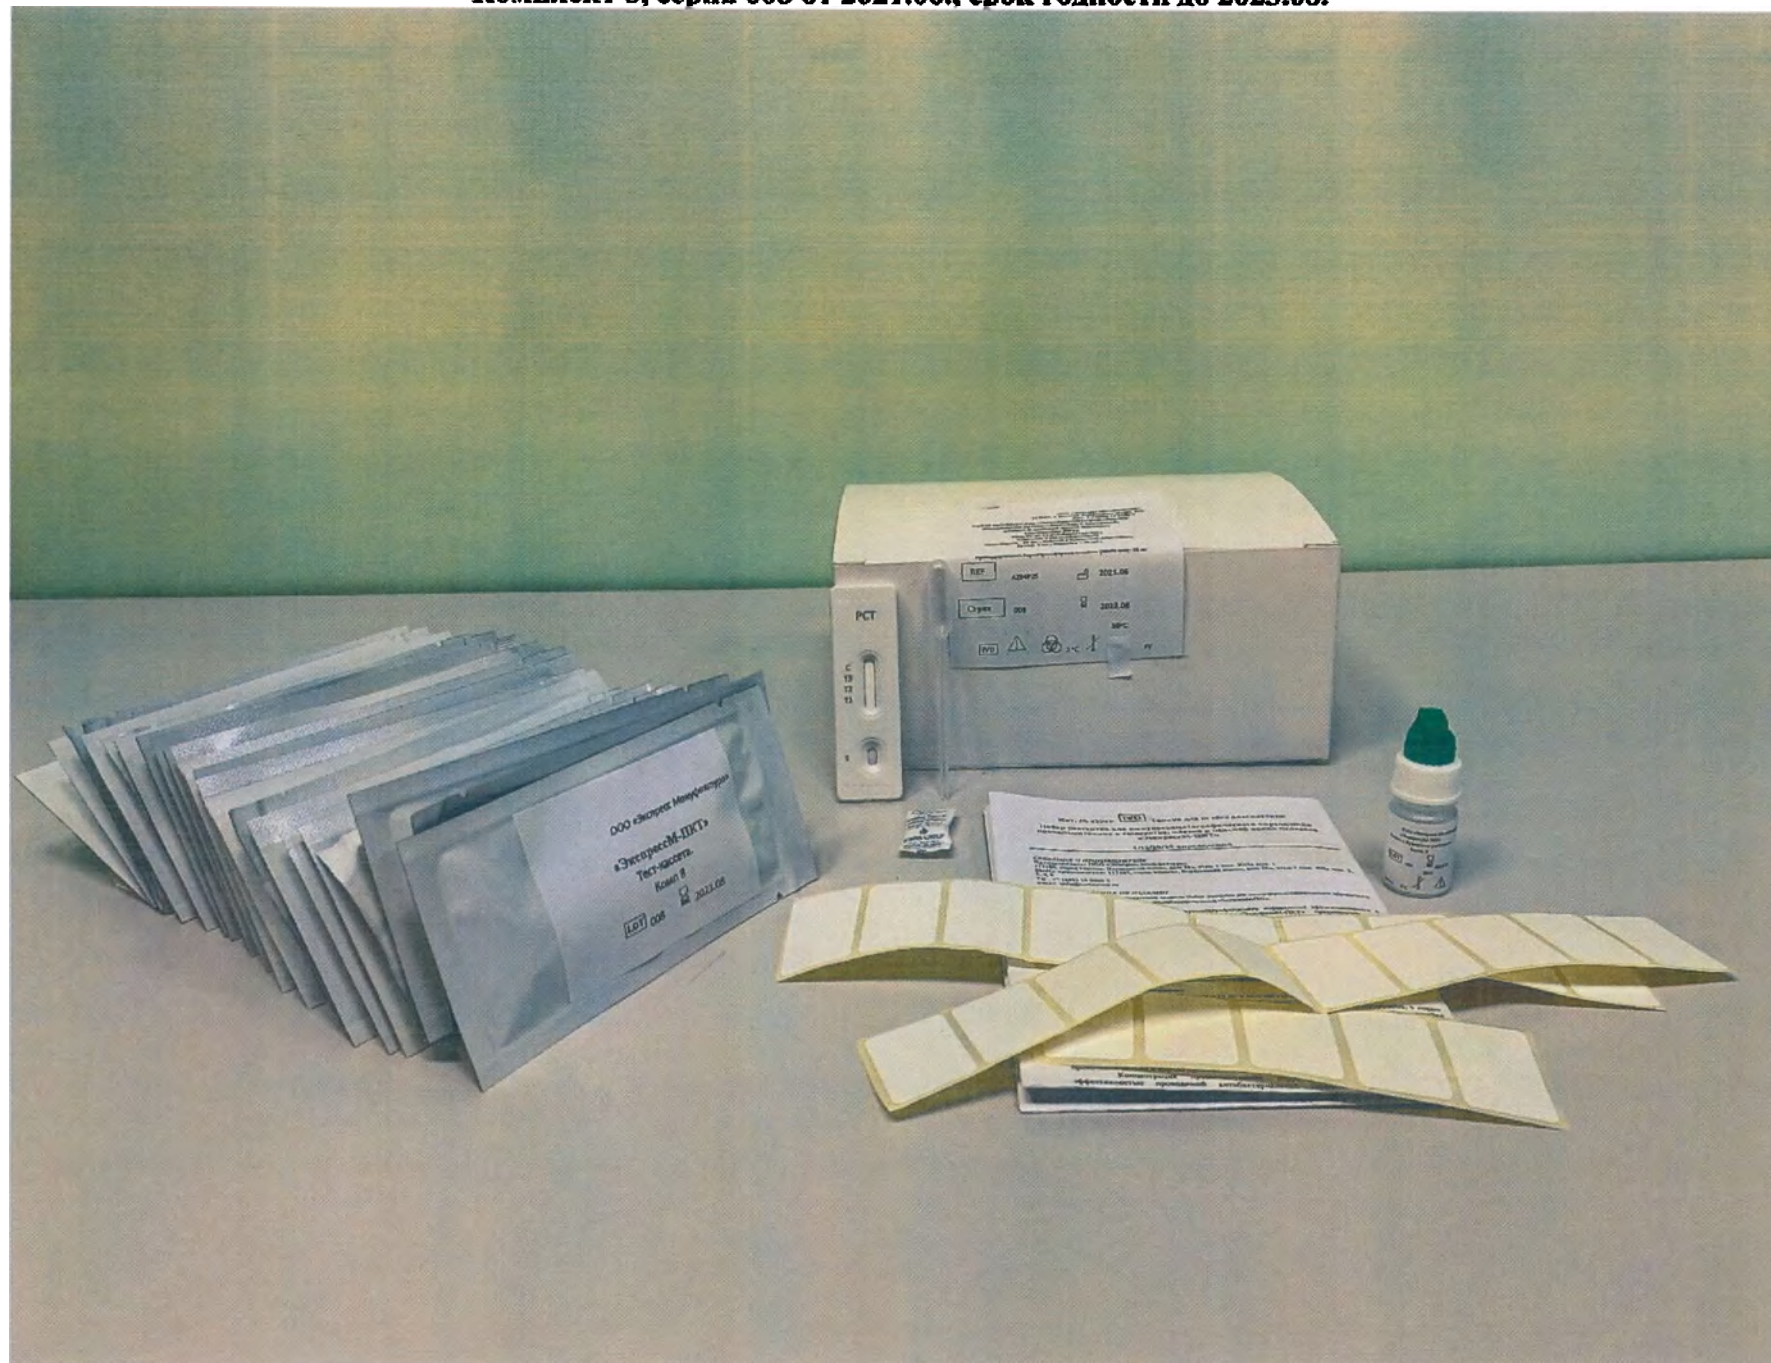

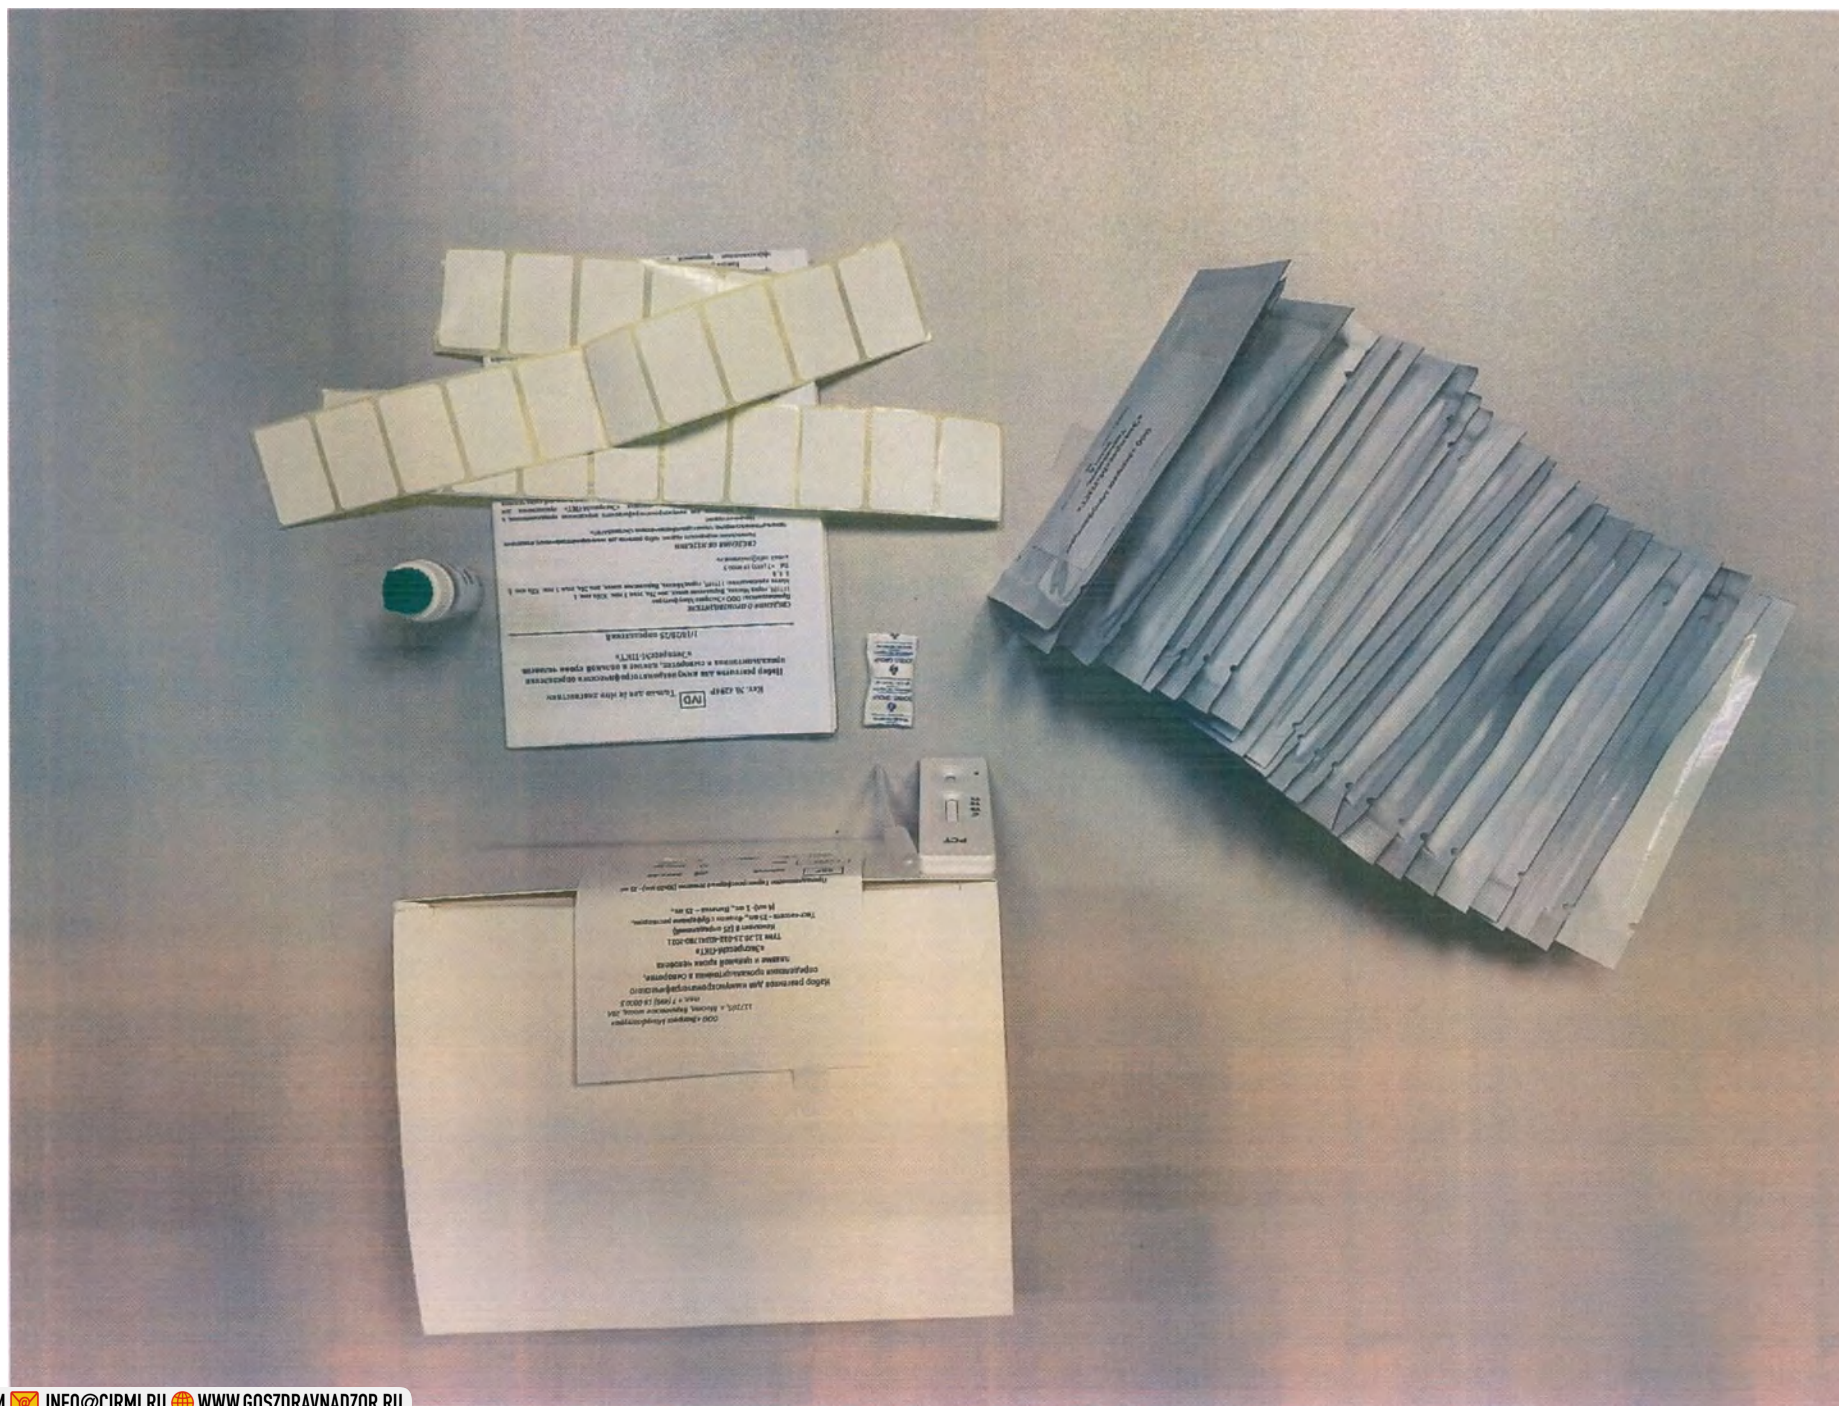

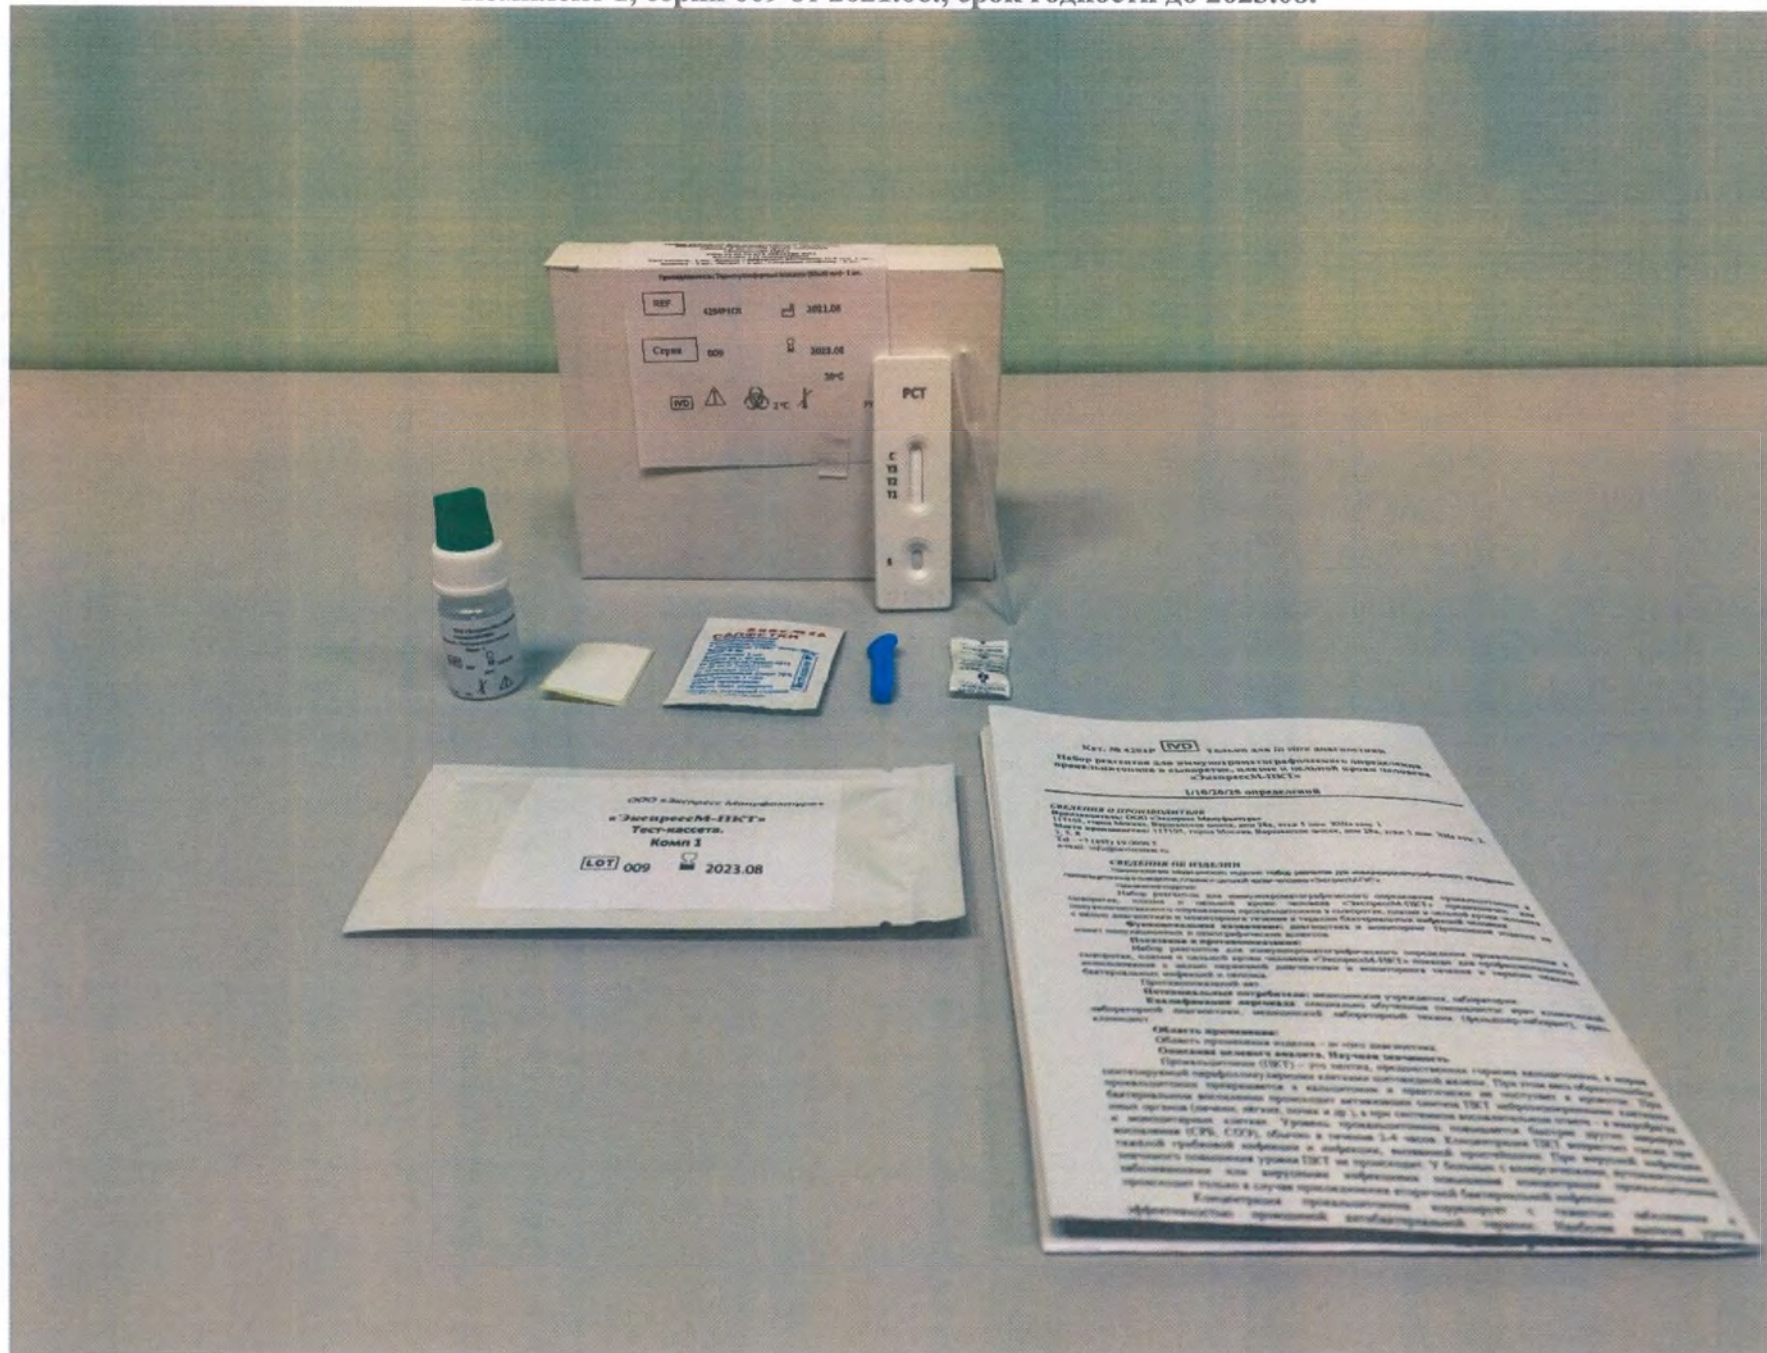

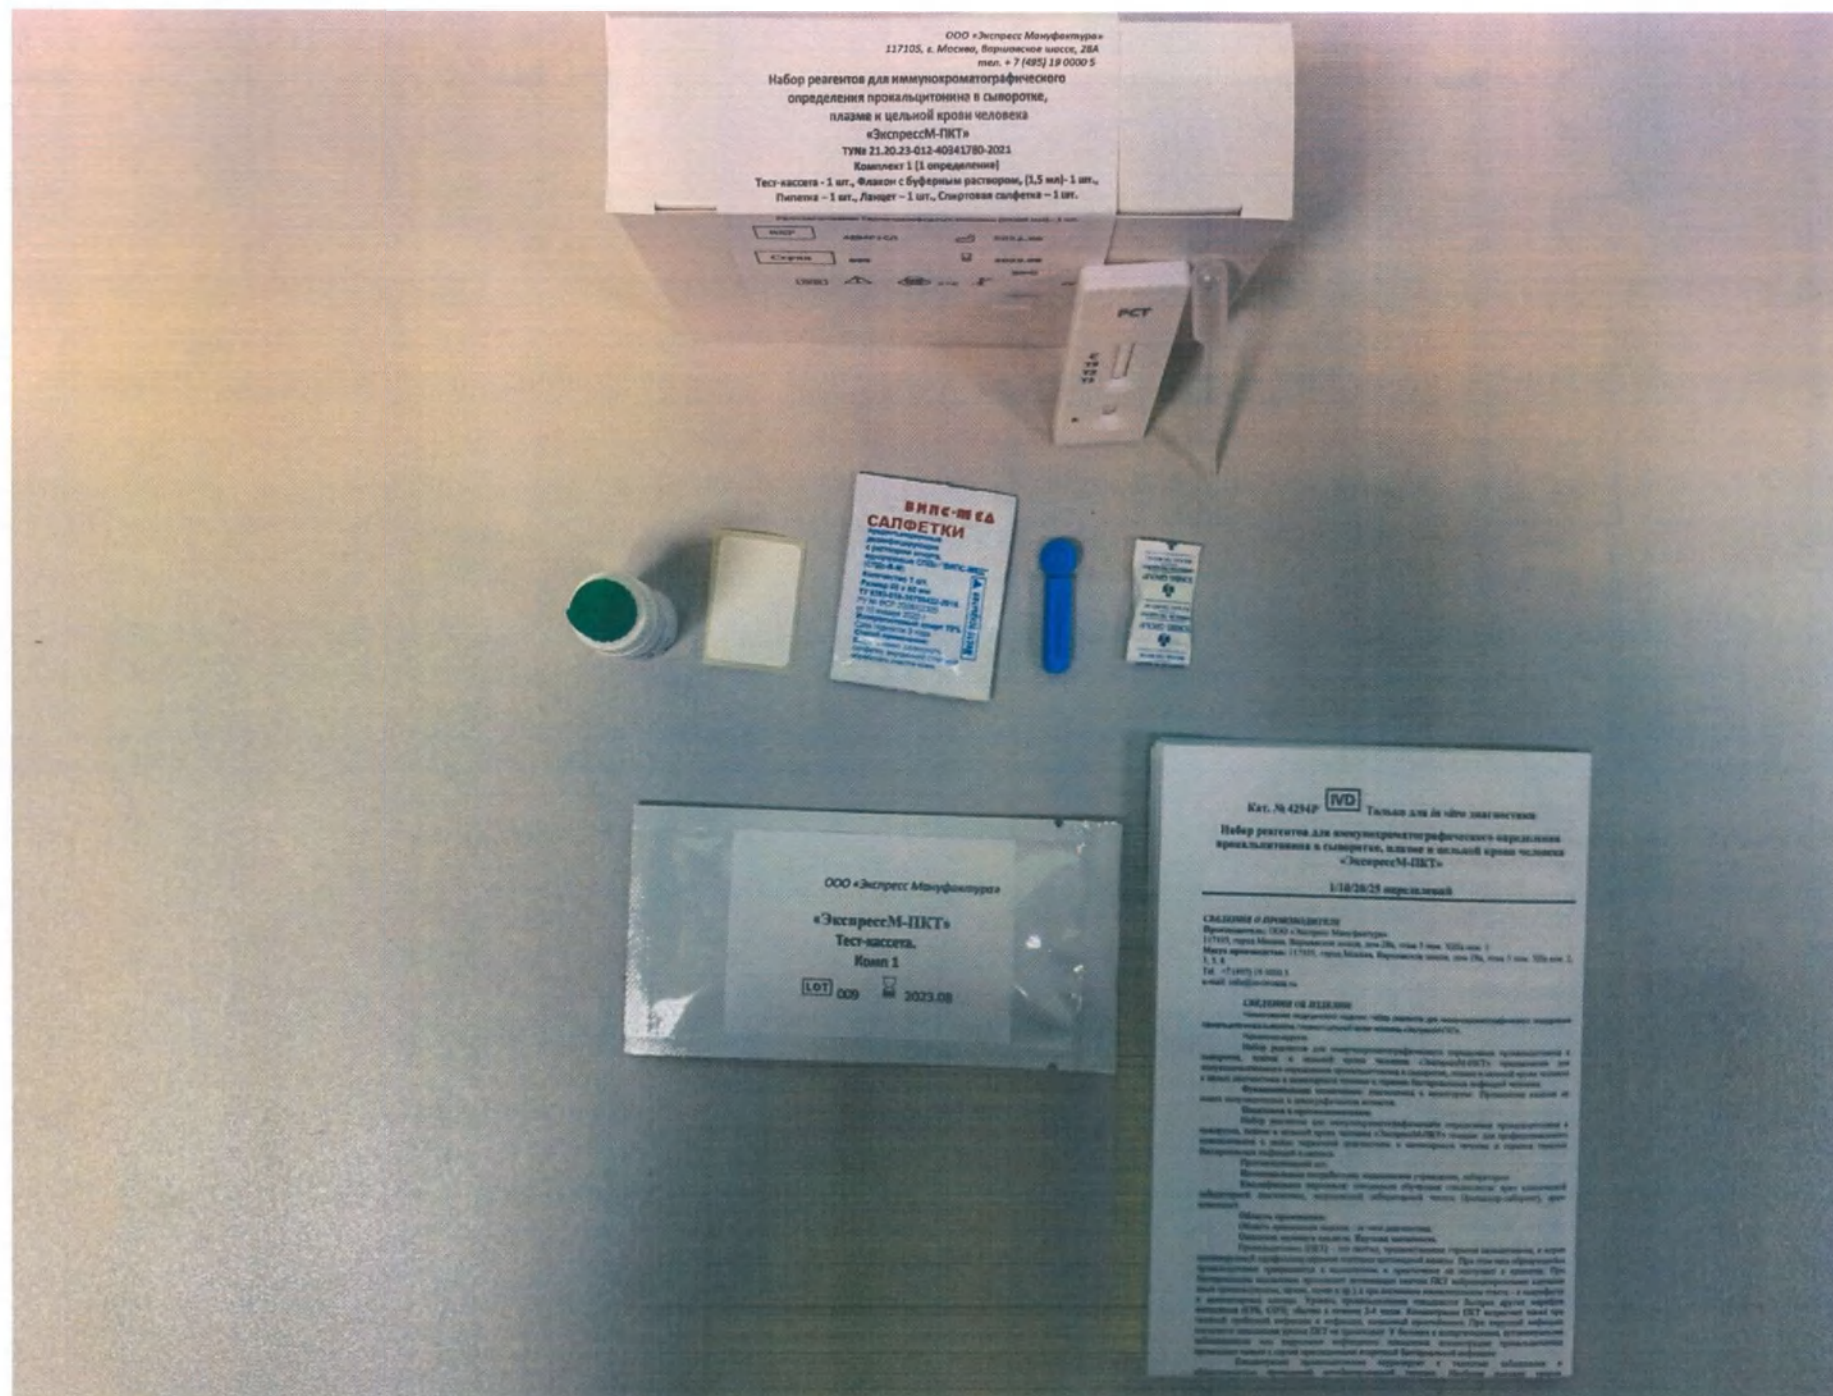


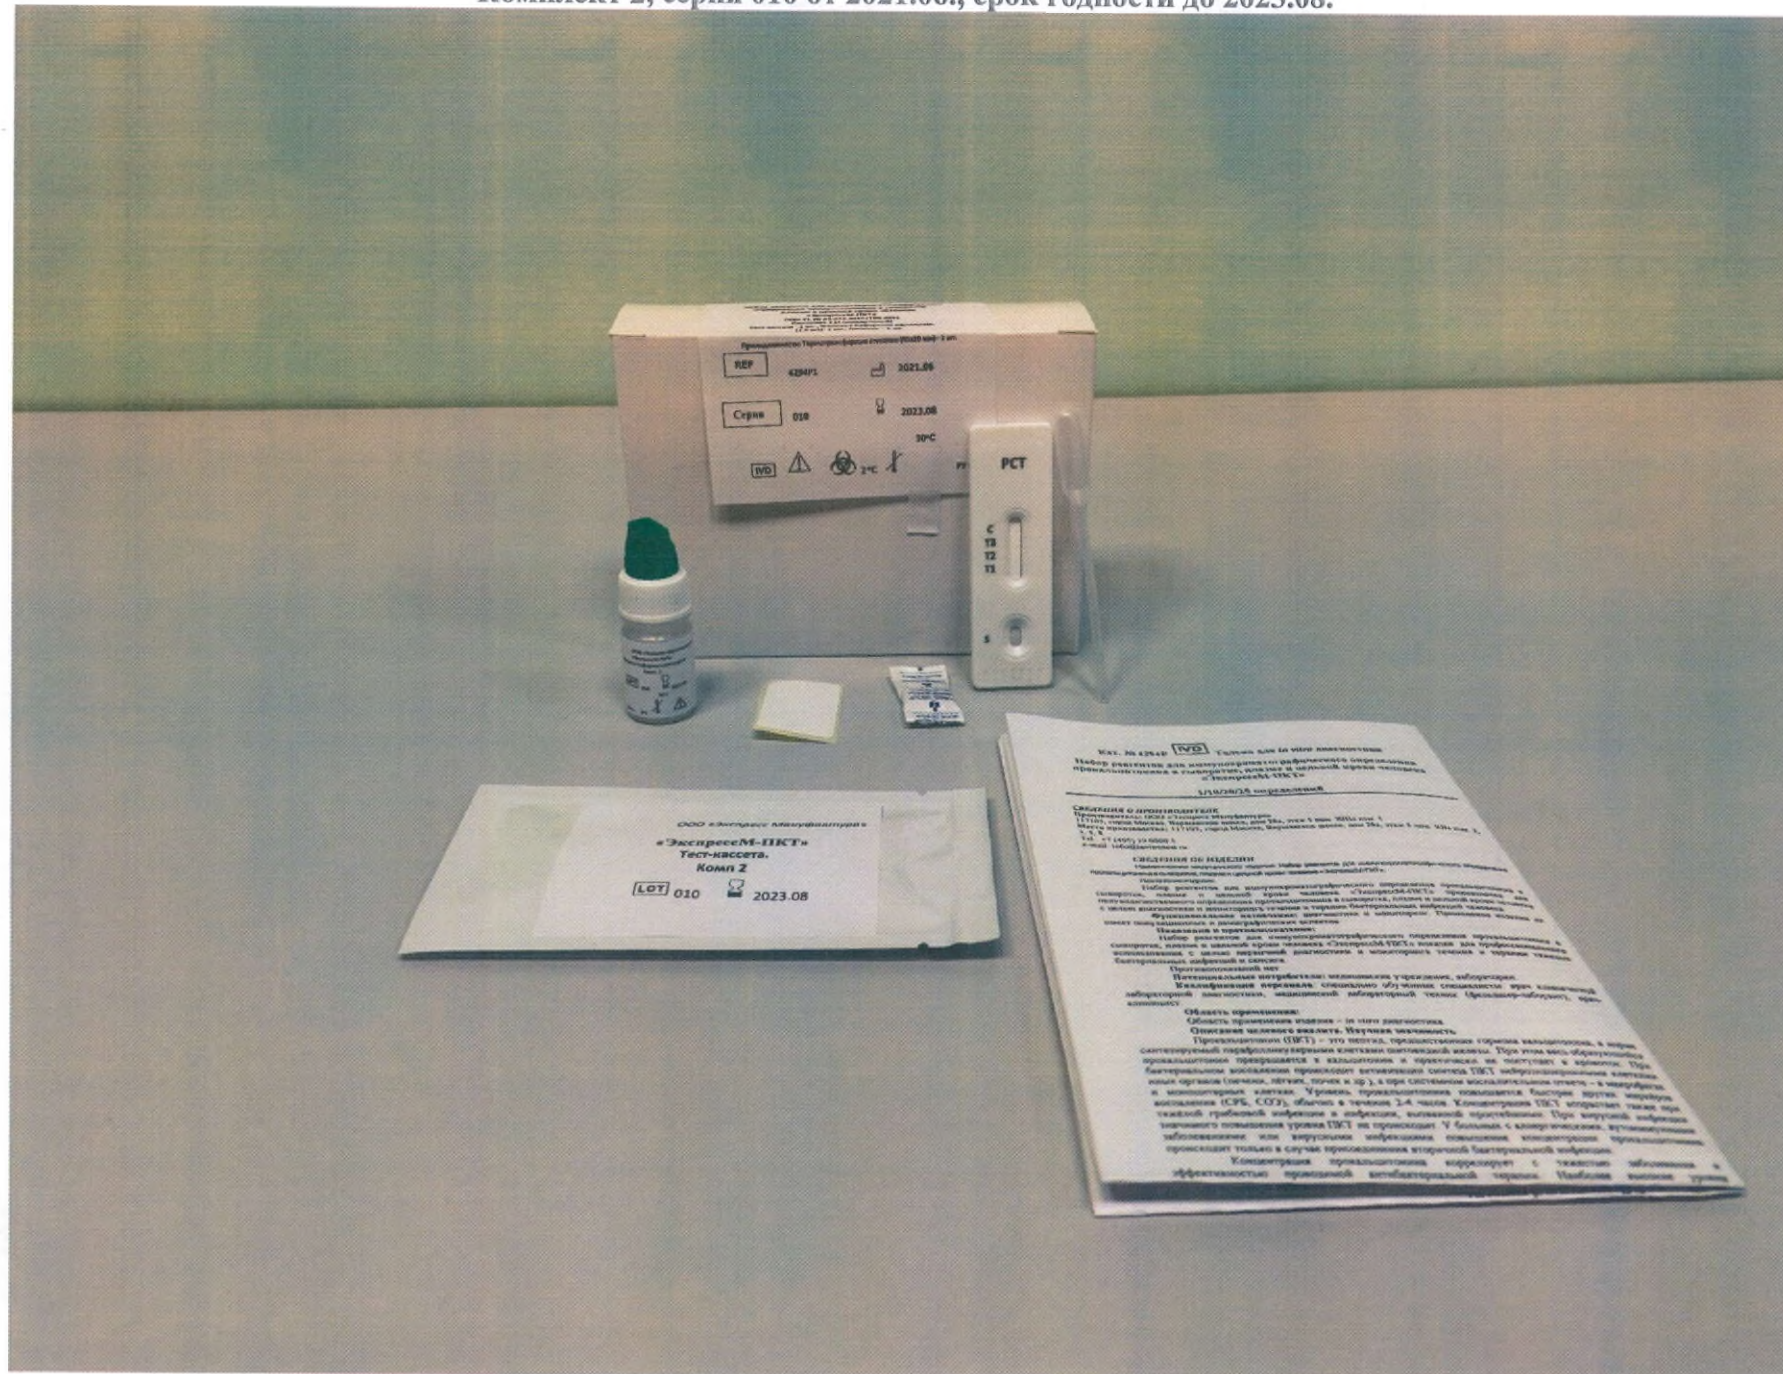

ООО «Экспресс-МедиаФарма»
117105, г. Москва, Вулканская улица, д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (495) 117 0000 5

Набор реагентов для иммунохроматографического
определения проангиотина в сыворотке,
плазме и цельной крови человека

«Экспресс-М-ПКТ»
ТУ 92 21.30.23-012-0031780-2021
Комплект 2 (10 тестовых планшетов)
Тест-набор - 1 шт., Флакон с буферным раствором,
(1,5 мл) - 1 шт., Пипетка - 1 шт.



Кат. № 034P **IVD** Только для in vitro диагностики


Набор реагентов для иммунохроматографического определения проангиотина в сыворотке, плазме и цельной крови человека «Экспресс-М-ПКТ»


1/1028/25 проанализов


СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ООО «Экспресс-МедиаФарма»
117105, г. Москва, Вулканская улица, д. 10, стр. 1
Место производства: 117105, г. Москва, Вулканская улица, д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (495) 117 0000 5
e-mail: info@expmed.ru

СВЯЗАННЫЕ СБ 61318.1018
Наименование медицинского изделия: набор реагентов для иммунохроматографического определения проангиотина в сыворотке, плазме и цельной крови человека «Экспресс-М-ПКТ»
Назначение: для определения проангиотина в сыворотке, плазме и цельной крови человека «Экспресс-М-ПКТ»
Применение: для определения проангиотина в сыворотке, плазме и цельной крови человека «Экспресс-М-ПКТ»
Виды контроля: визуальный контроль результатов тестирования
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления
Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +2 до +25 °C
Состав: 1 шт. тест-набор, 1 шт. флакон с буферным раствором, 1 шт. пипетка


ООО «Экспресс-МедиаФарма»
Тест-набор
«Экспресс-М-ПКТ»
Комп. 2
LOT 010 2023.08

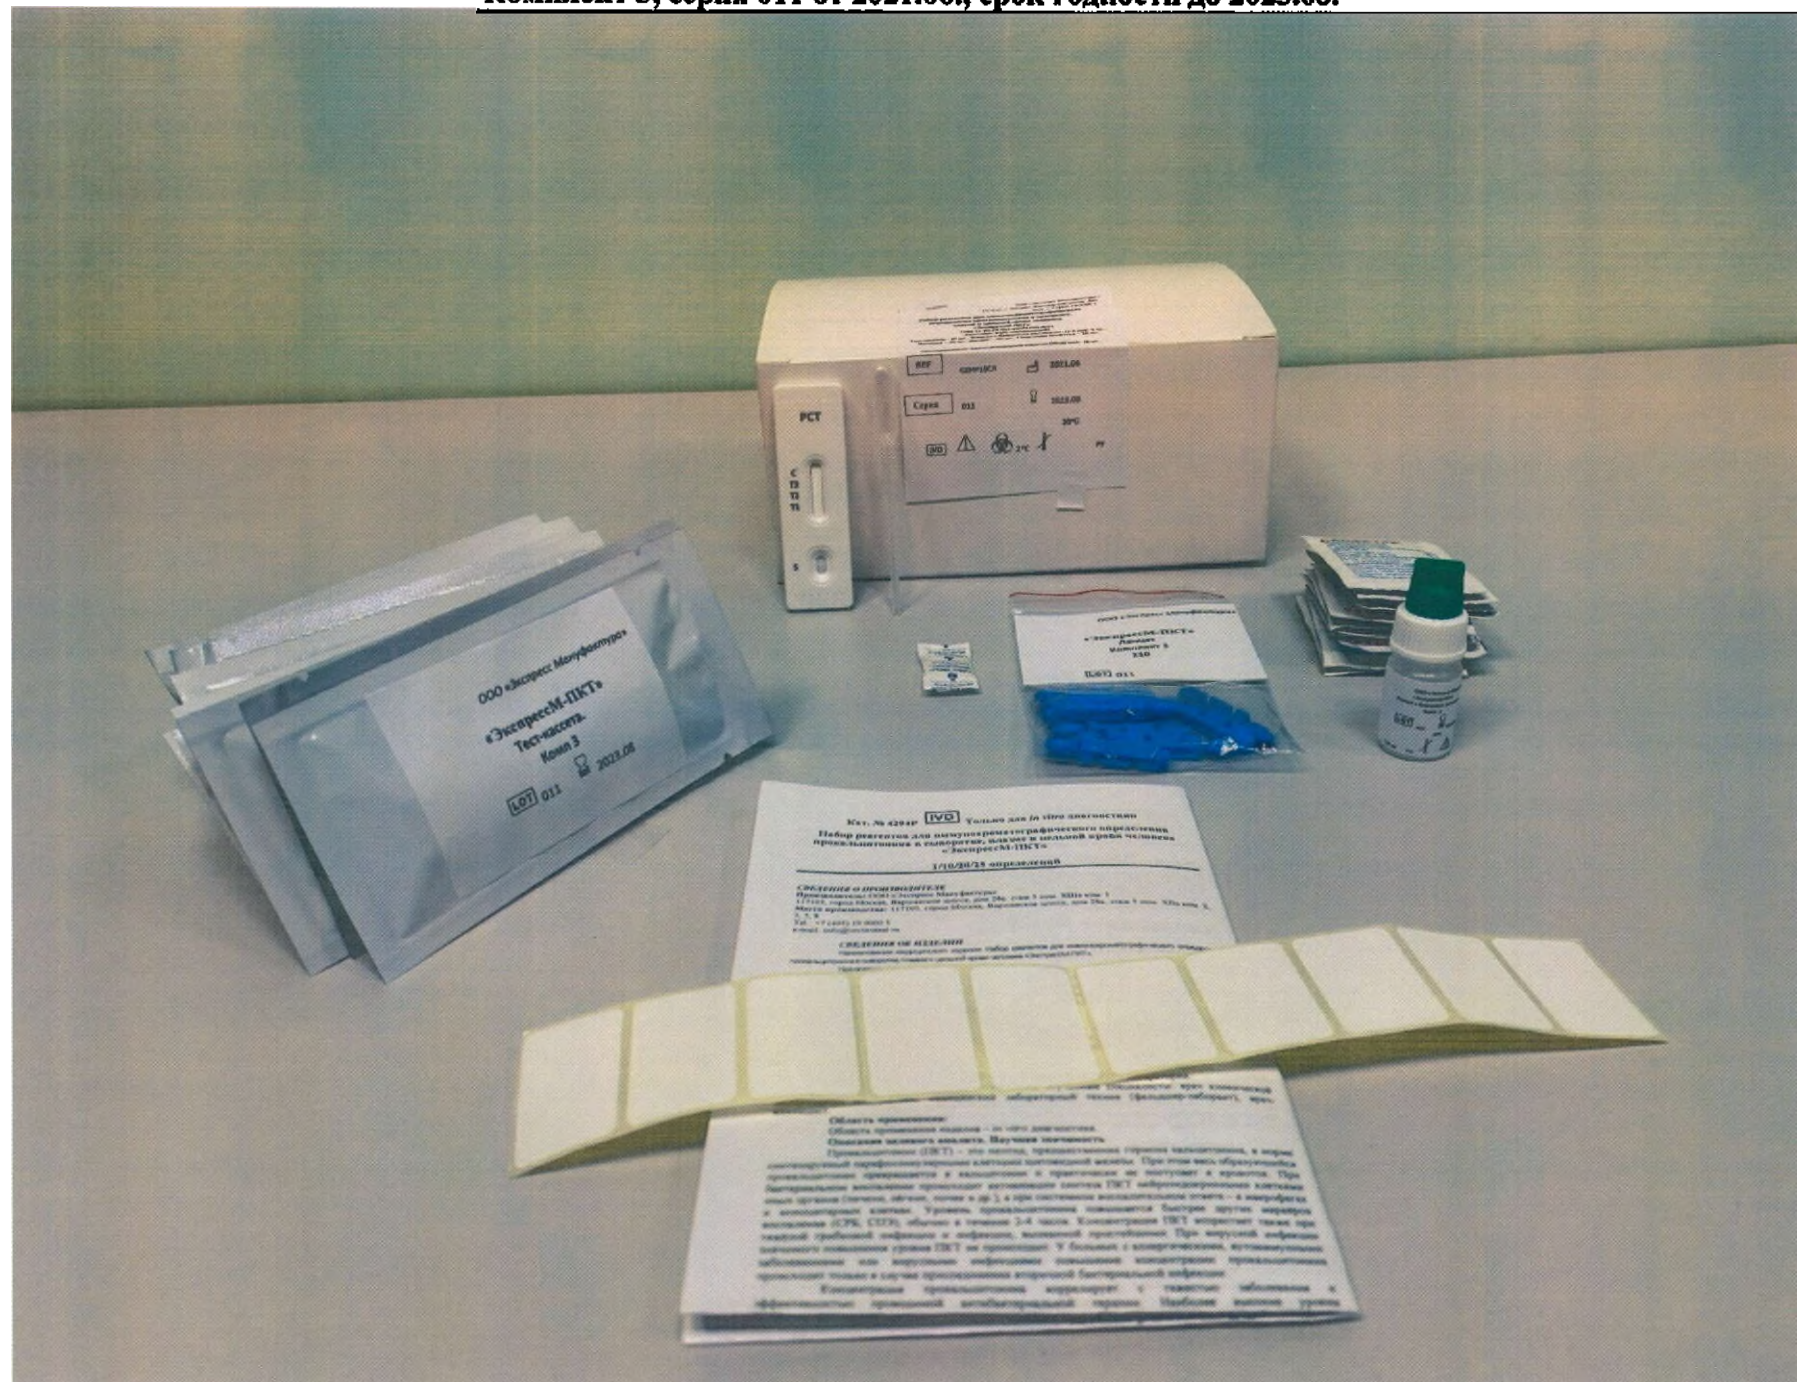


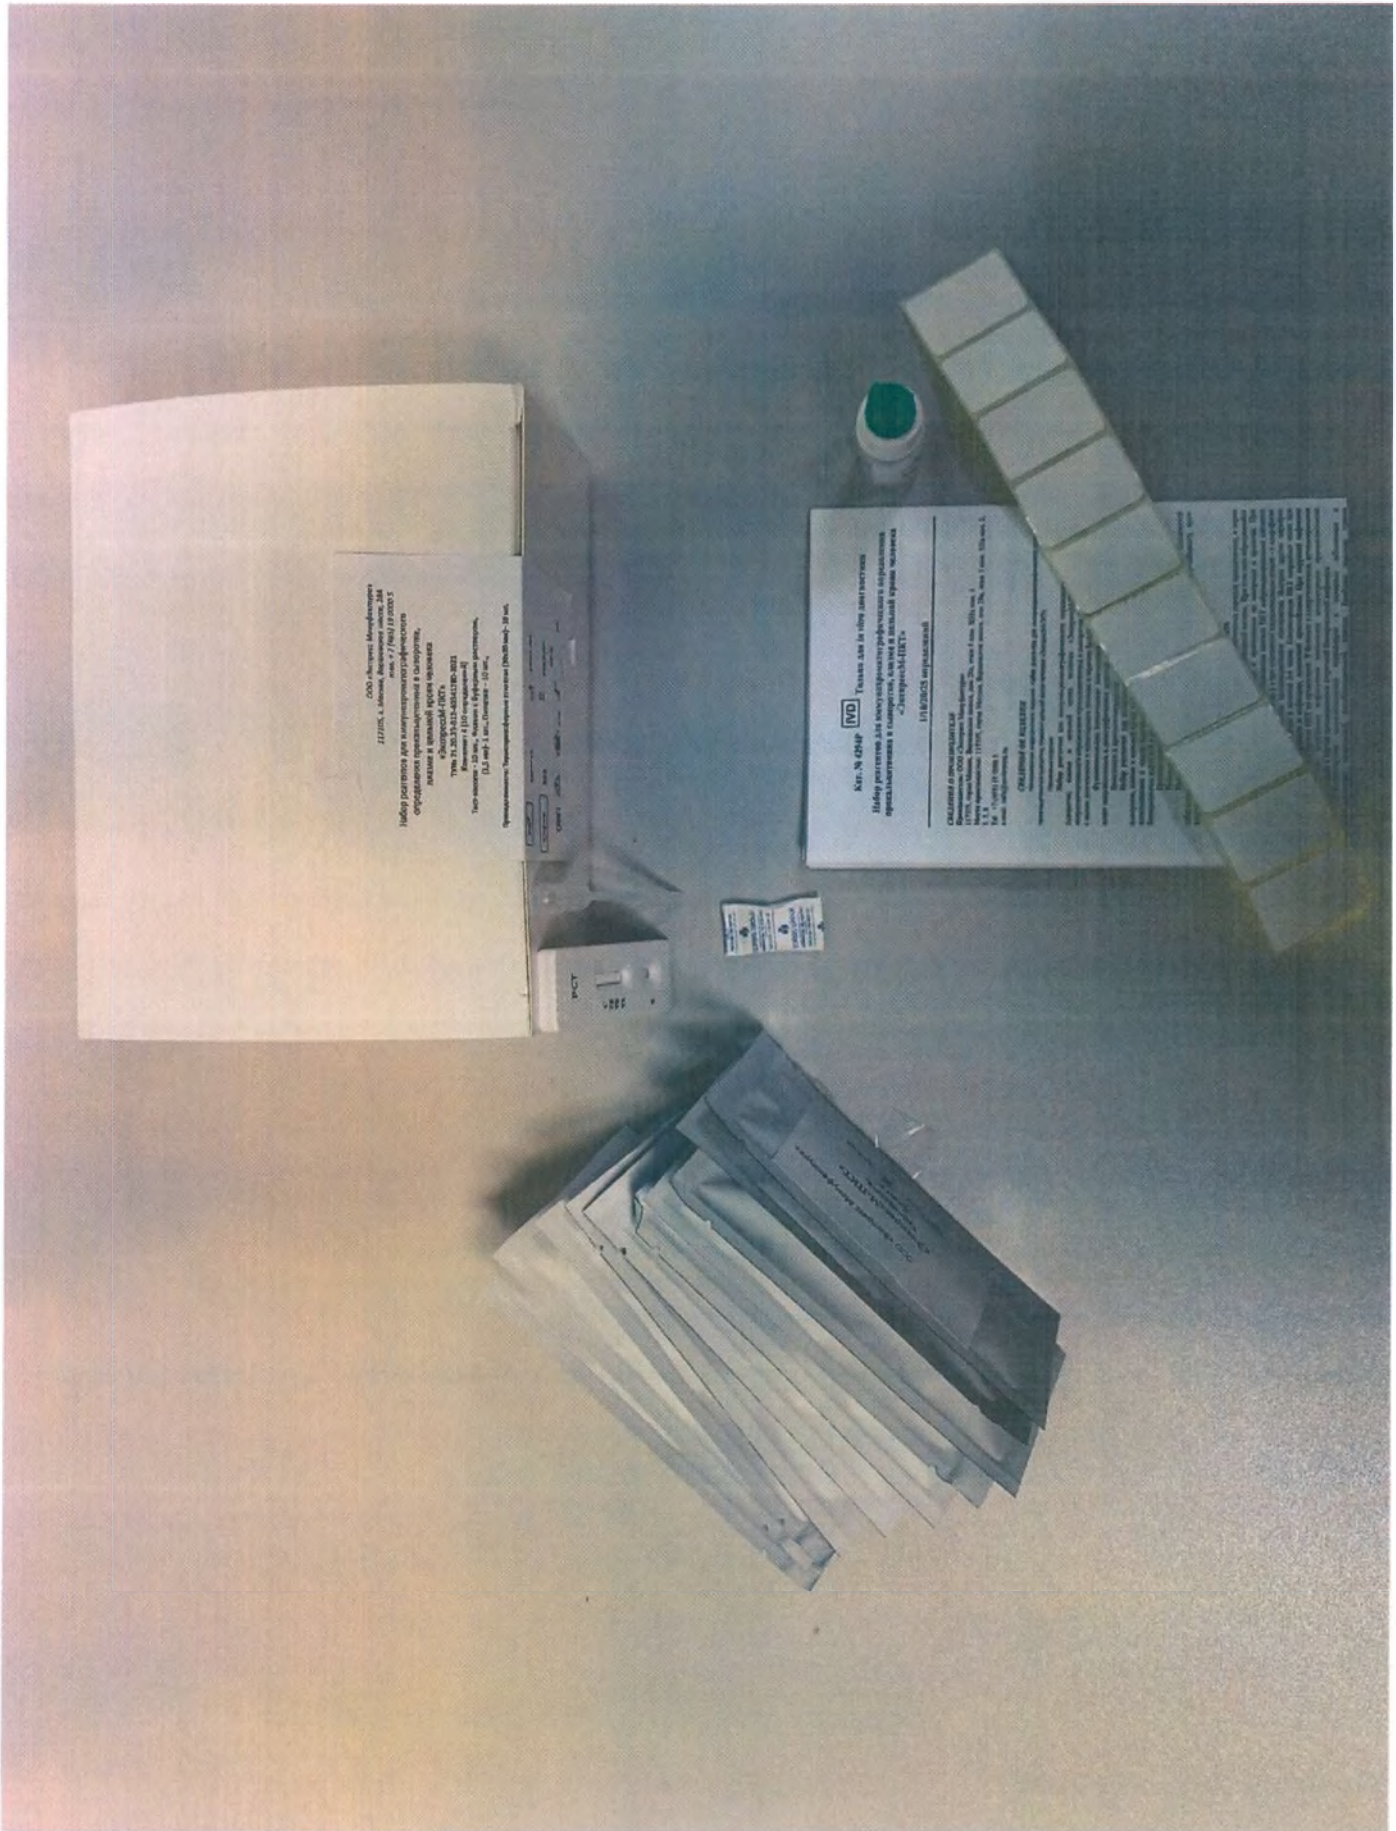


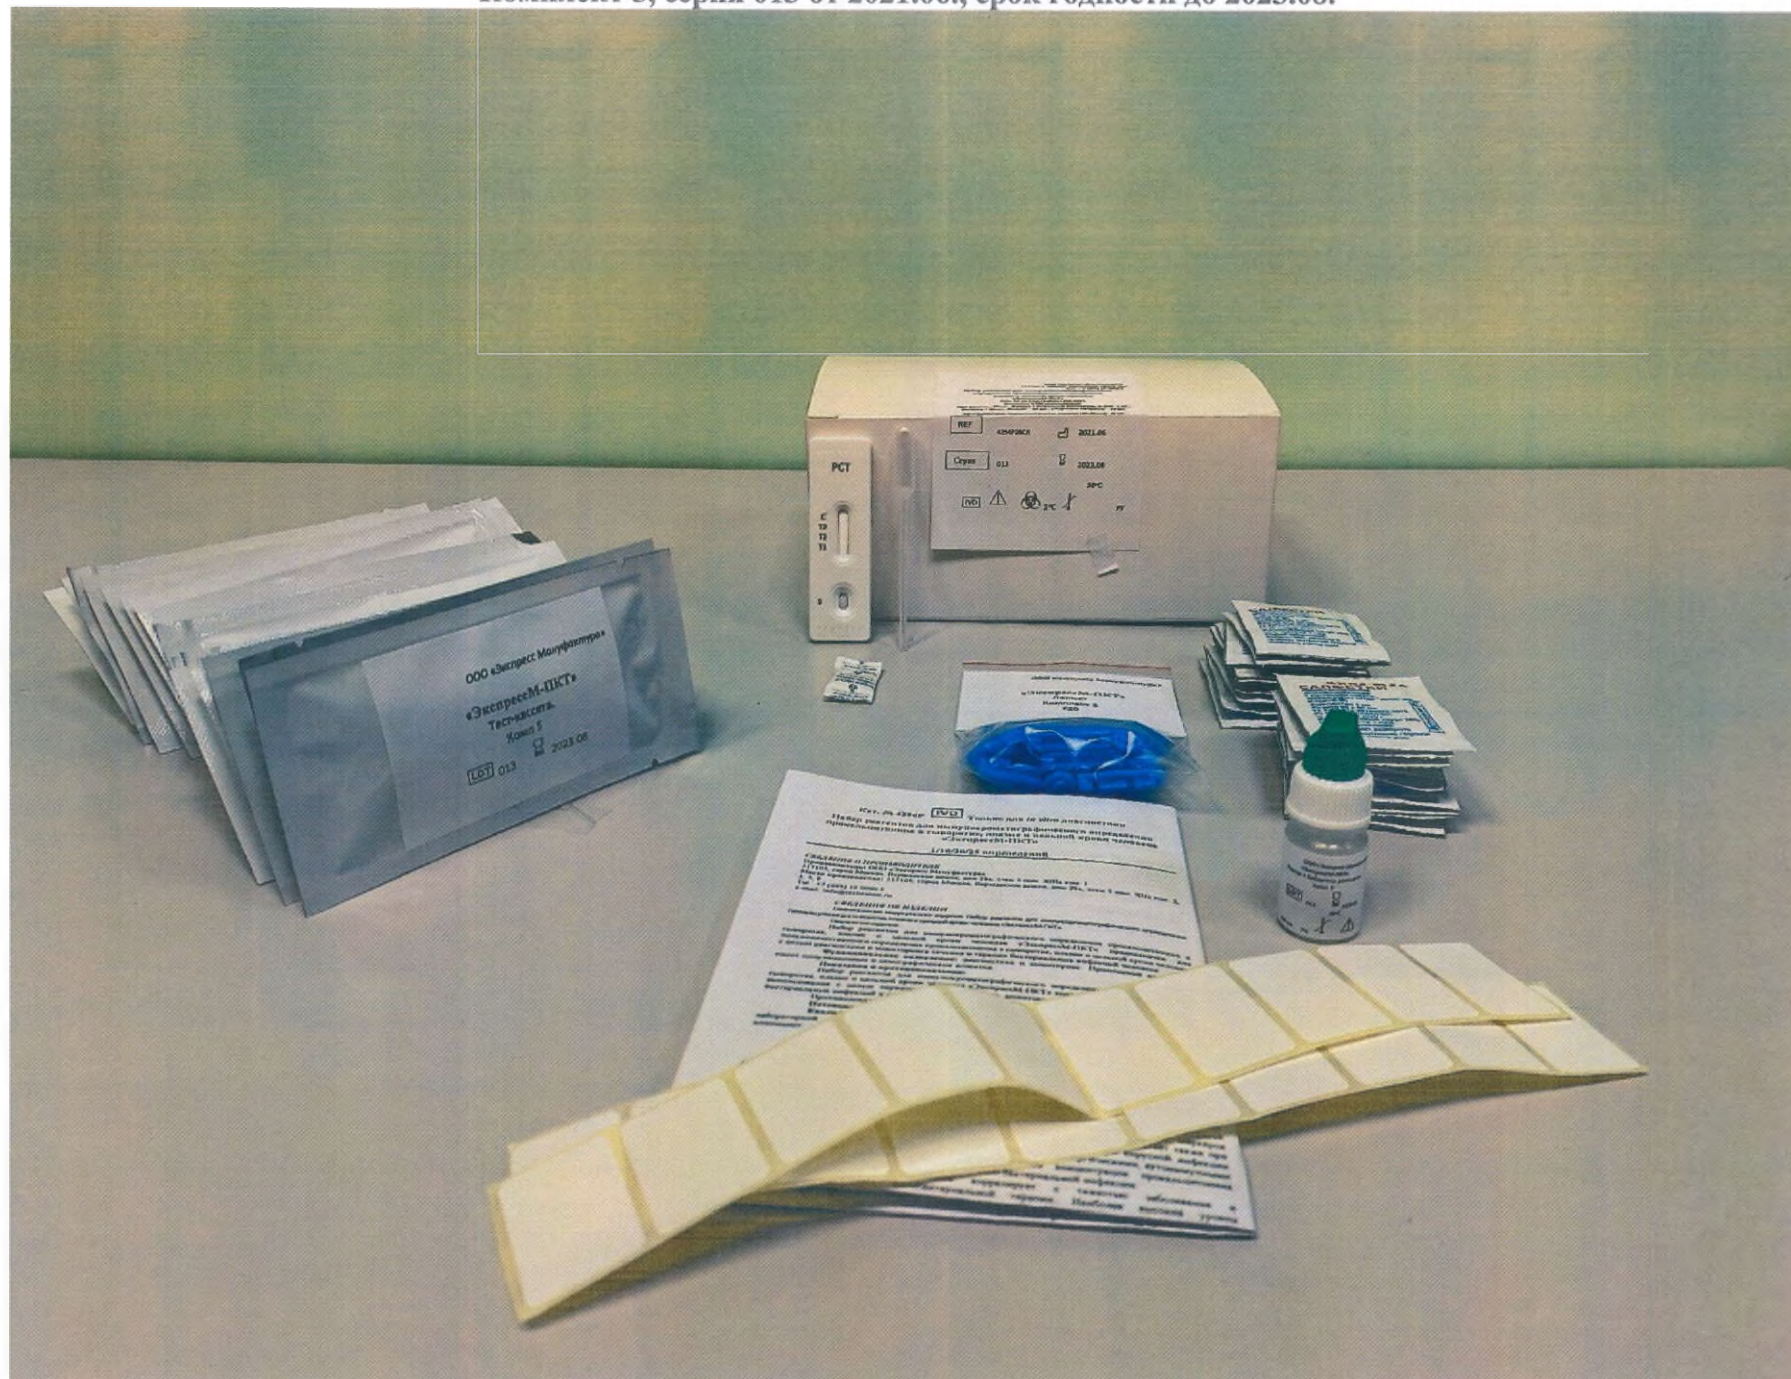



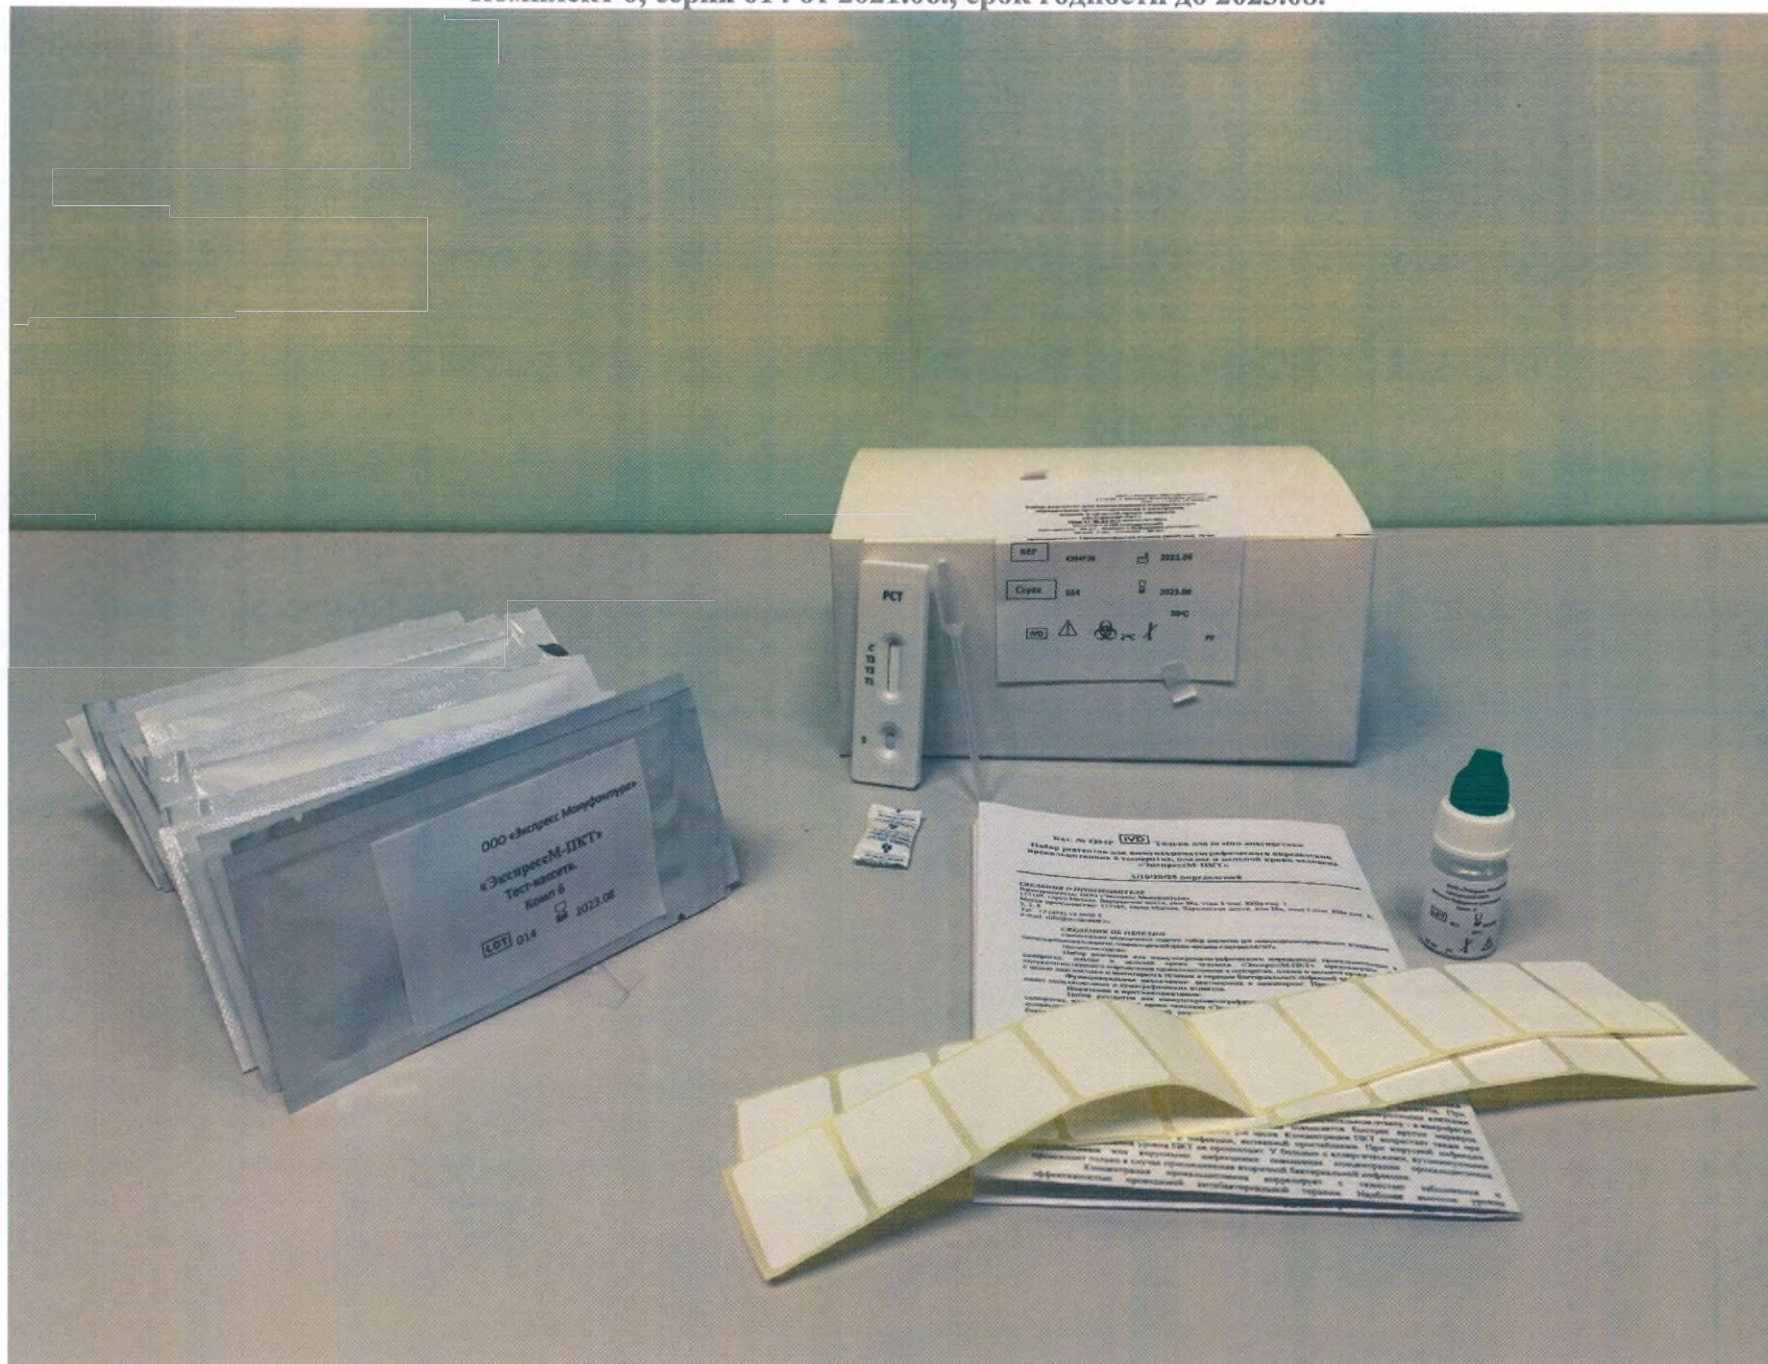

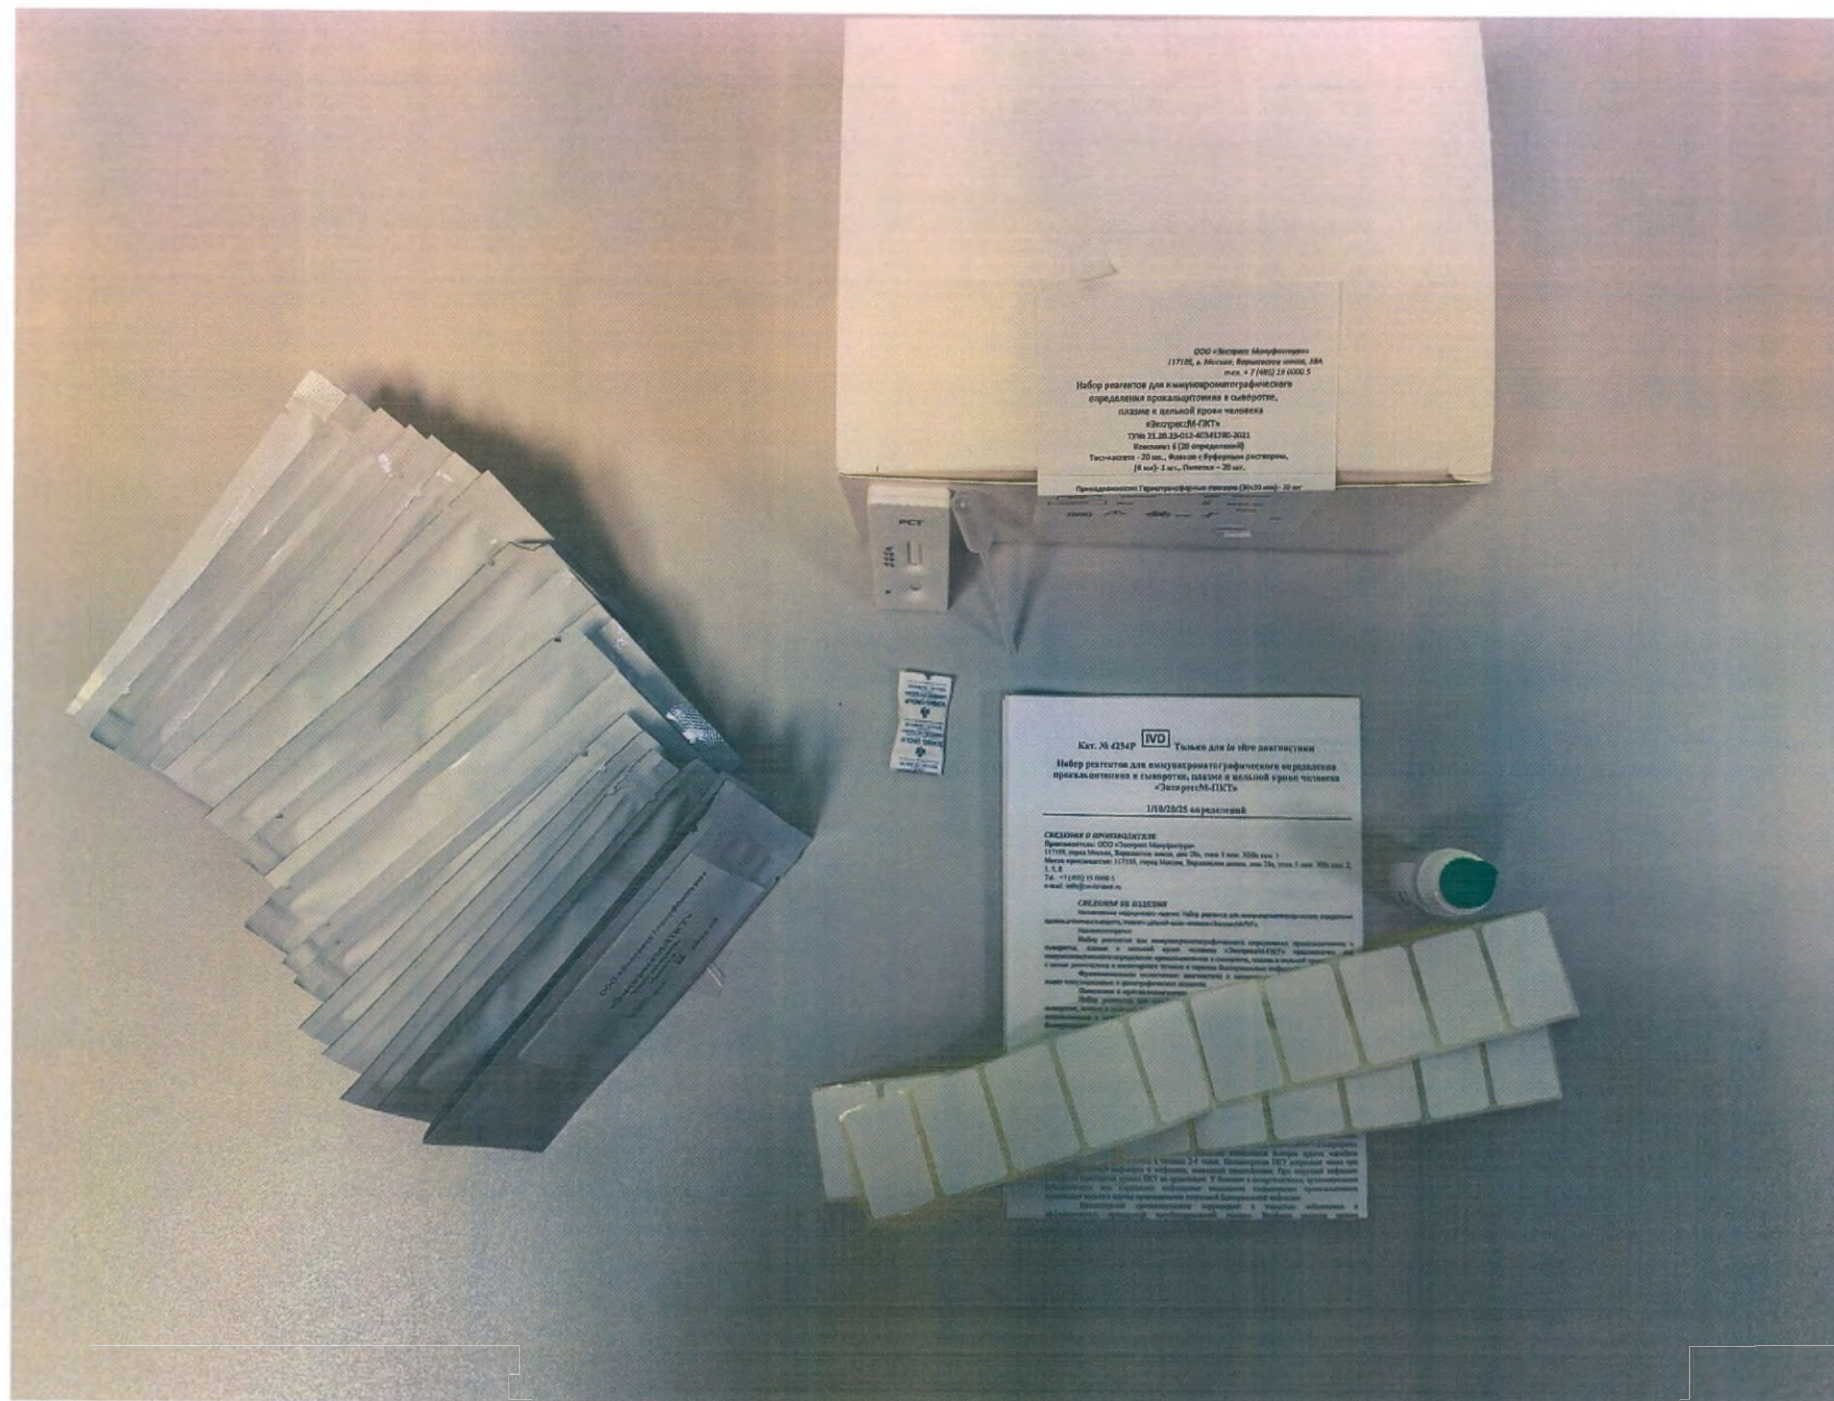


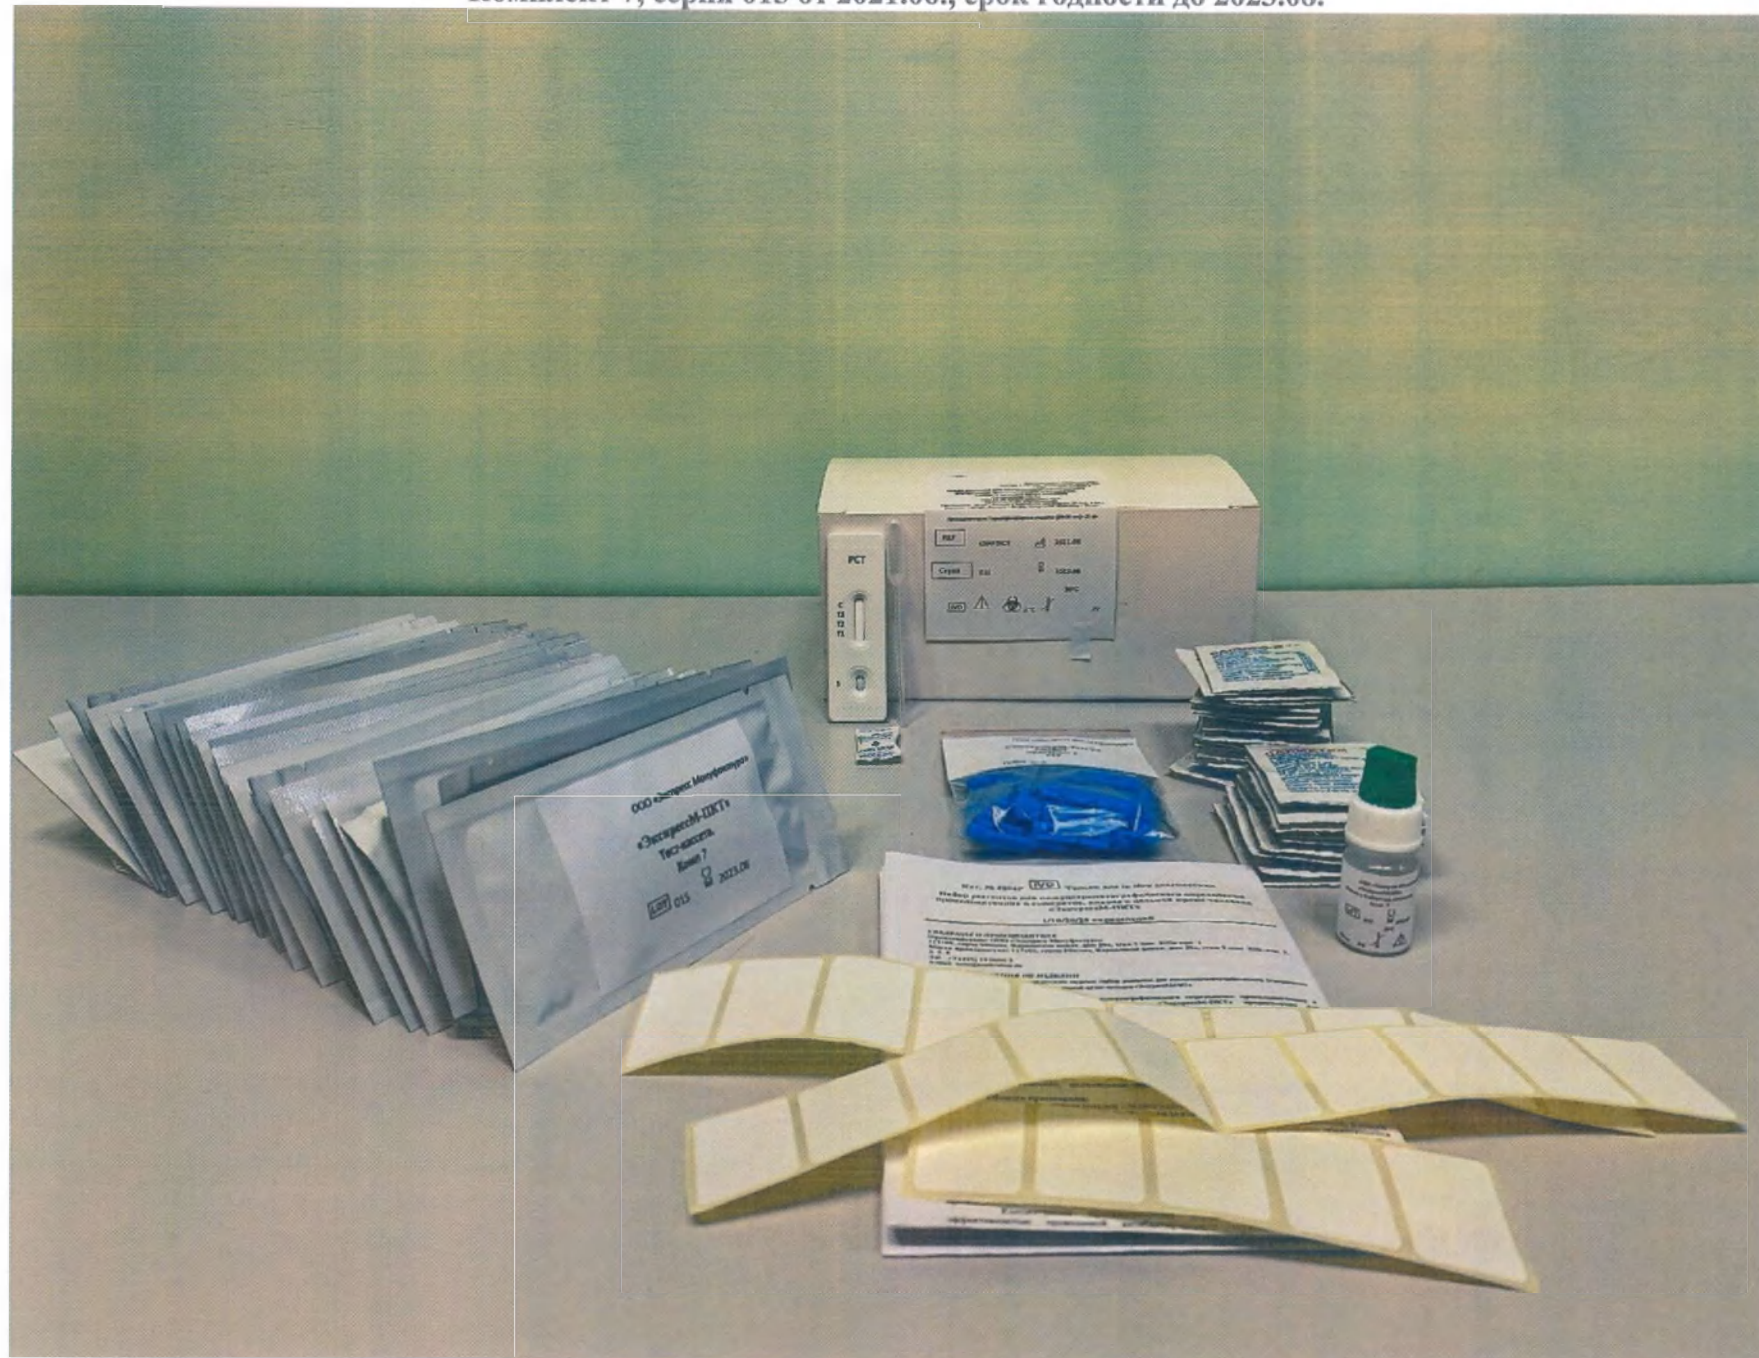





Фотографические изображения компонентов Набор реагентов для иммунохроматографического определения прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови человека «ЭкспрессМ-ПКТ», имеющих маркировку

1. Тест-кассета

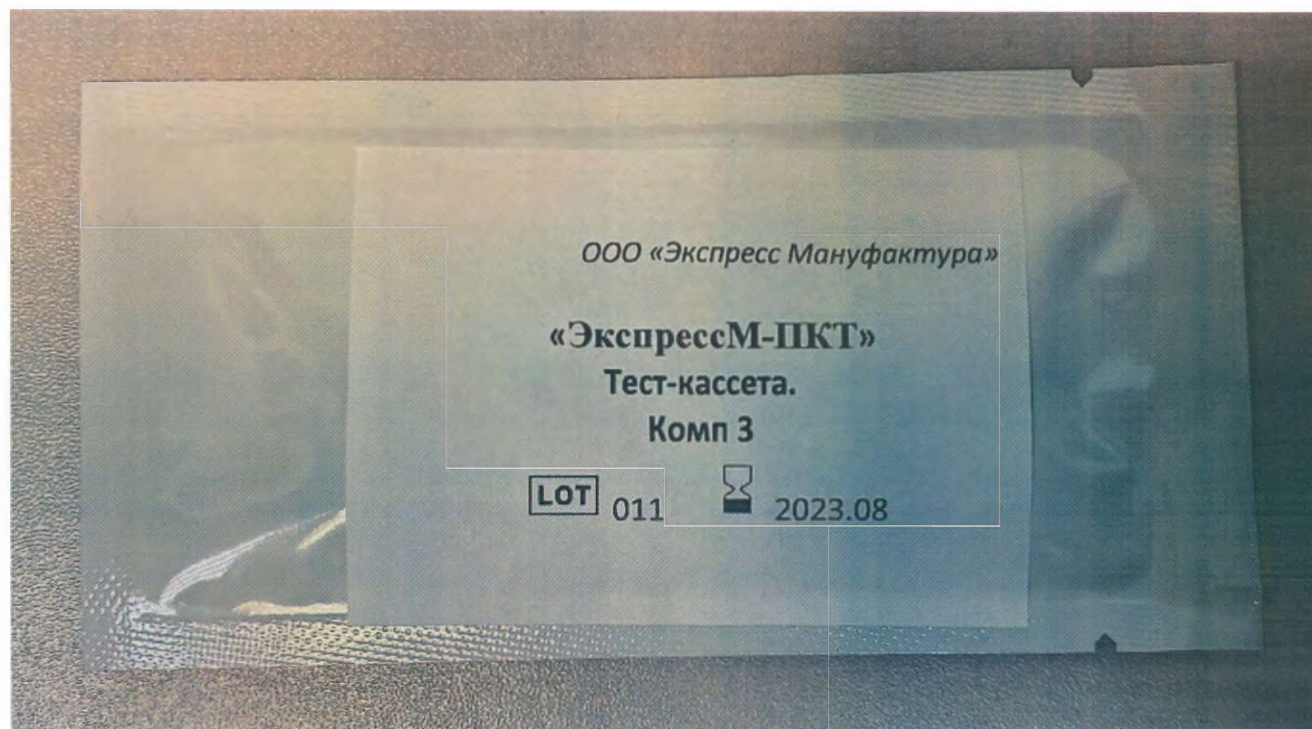

2. Флакон с буферным раствором

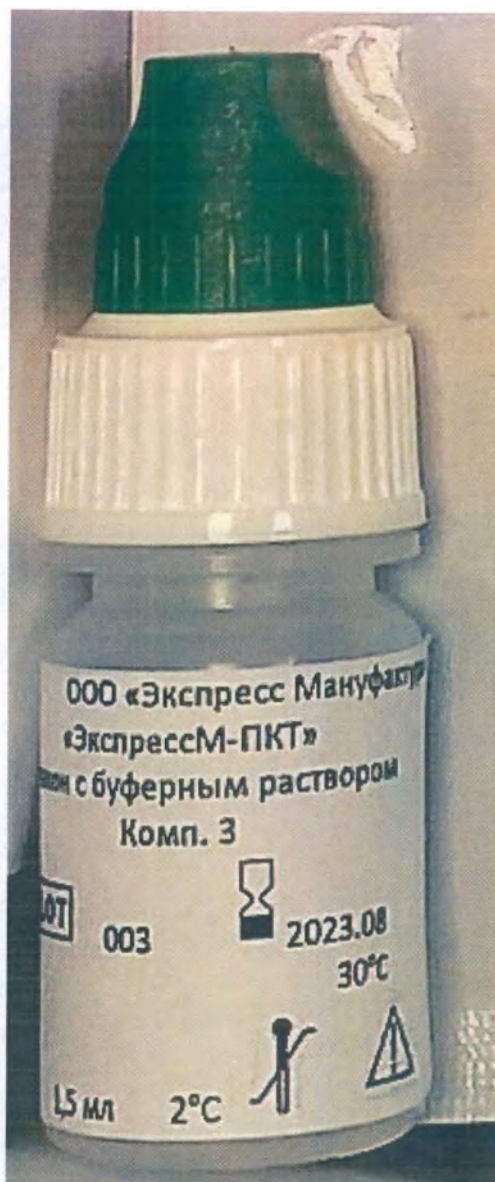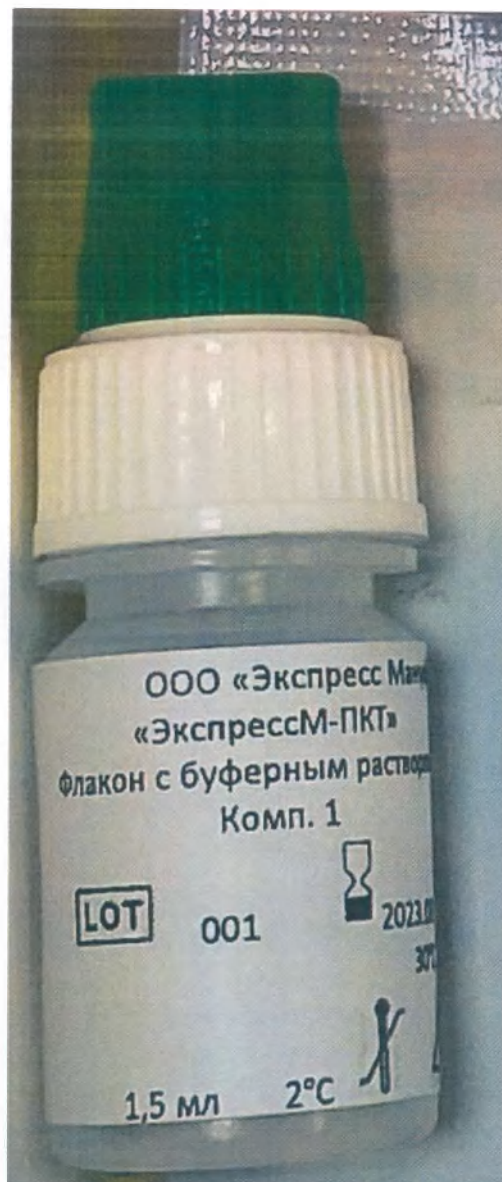


3. Ланцет



4. Спиртовая салфетка



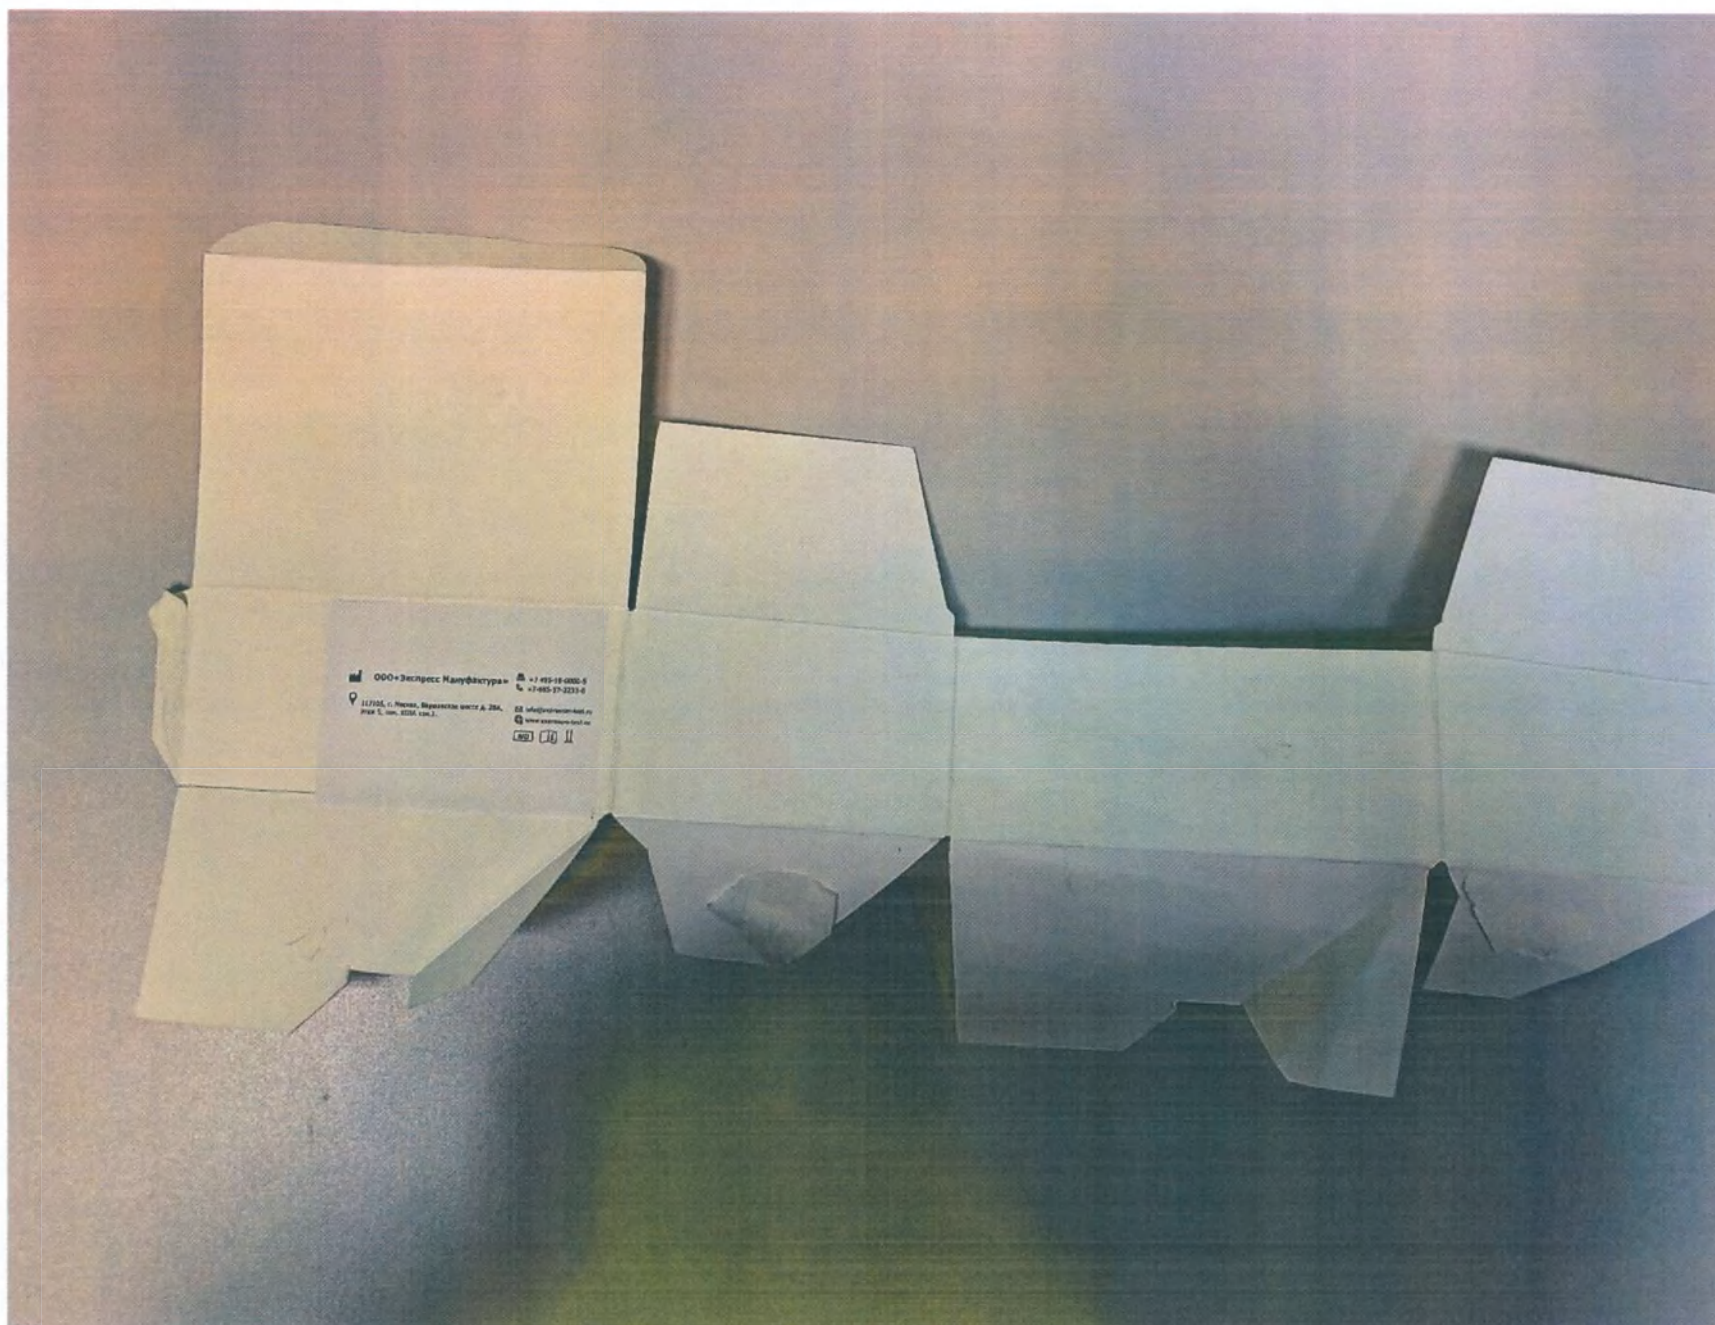

ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

**Набор реагентов для иммунохроматографического
определения прокальцитонина в сыворотке,
плазме и цельной крови человека**

«ЭкспрессМ-ПКТ»

ТУ № 21.20.23-012-40341780-2021

Комплект 3 (10 определений)

Тест-кассета - 10 шт., Флакон с буферным раствором, (1,5 мл) - 1 шт.,
Пипетка - 10 шт., Ланцет - 10 шт., Спиртовая салфетка - 10 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 10 шт.

REF

4294P10СЛ



2021.06

Серия

011



2023.08

30°C

IVD



2°C



РУ

Генеральный директор ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И.В.

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

38 листов


Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И. В.

« 19 » 07 2019 г.





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И.В.
« 15 » _____ июня _____ 2022 г.

ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для иммунохроматографического определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови человека

«ЭкспрессМ-ПКТ»

ТУ № 21.20.23-012-40341780-2021

Комплект 1 (1 определение)

Тест-кассета - 1 шт., Флакон с буферным раствором,
(1,5 мл) - 1 шт., Пипетка - 1 шт., Ланцет - 1 шт., Спиртовая салфетка - 1 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 1 шт.

REF 4294P1CL  2021.06

Серия 001  2023.08

30°C
IVD   2°C  РУ

ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для иммунохроматографического определения
прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови человека

«ЭкспрессМ-ПКТ»

ТУ № 21.20.23-012-40341780-2021

Комплект 2 (1 определение)

Тест-кассета - 1 шт., Флакон с буферным раствором,
(1,5 мл) - 1 шт., Пипетка - 1 шт.

Принадлежности: Термотрансферные этикетки (30x20 мм) - 1 шт.

REF 4294P1  2021.06

Серия 002  2023.08

30°C
IVD   2°C  РУ

ООО «Экспресс Мануфактура»

«ЭкспрессМ-ПКТ»

Тест-кассета.

Комп 1

LOT 001  2023.08

ООО «Экспресс Мануфактура»

«ЭкспрессМ-ПКТ»

Флакон с буферным раствором

Комп. 1

LOT 001  2023.08
30°C

1,5 мл 2°C  

ООО «Экспресс Мануфактура»

«ЭкспрессМ-ПКТ»

Ланцет

Комплект 3

Σ10

LOT 003

Наименование предприятия-изготовителя, контакты, знаки «только для in vitro
диагностики» и «обратитесь к инструкции по применению» указаны на этикетке:



ООО «Экспресс Мануфактура»



+7 495-19-0000-5



+7-985-57-2233-0



117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 28А,
этаж 5, пом. ХППА ком.1.



info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru



Начальник производства

Начальник отдела контроля качества

А.А. Ивчин

М.А. Лесняк



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

2 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»
Киреев И. В.

« 19 » 07 2022 г.