



117105, ГОРОД МОСКВА,
ВВ. ВАРШАВСКОЕ, Д. 28А, ЭТАЖ 5 ПОМ. Х2А ном.1
Факт. адрес: 117105, ГОРОД МОСКВА,
ВВ. ВАРШАВСКОЕ, Д. 28А, ЭТАЖ 5 ПОМ. Х2А ном.2, 3, 5, 8

+7 (495) 190-00-05
+7 (985) 572-13-30
info@expressm-test.ru
expressm-test.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Мануфактура»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»
Киреев И.В.
« 15 » ИЮНЯ 2022 г.

Для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в
сыворотке крови человека методом латексной агглютинации

«Экспресс-М-РФ-латекс»

ТУ № 21.20.23-014-40341780-2021

Комплект 1 (100 определений)

РФ-реагент - 1 фл.(1,05 мл), РФ-позитив контроль - 1 фл.(0,1 мл),
РФ-слабопозитив контроль - 1 фл.(0,1 мл), РФ-негатив контроль - 1 фл.(0,1 мл),
Дискомент - 1 фл.(5 мл), Пипетки серологические и для переноса жидкостей
(Пастера) - 100 шт., Слайд многократного использования - 1 шт.,

Принадлежности: Палочка для смешивания - 50 шт.,
ИВБЛ, антигела и ВПЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

REF 1129RF100 2021.06
Серия 001 2023.12
8°C
IVD 2°C RU

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-РФ-латекс»
РФ-реагент
Комп. 1

LOT 001 2023.12

1,05 мл 2°C 8°C

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-РФ-латекс»
РФ-позитив контроль
Комп. 4

LOT 004 2023.12

0,5 мл 2°C 8°C

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-РФ-латекс»
РФ-слабоположительный контроль
Комп. 2

LOT 002 2023.12

0,25 мл 2°C 8°C

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-РФ-латекс»
РФ-негативный контроль
Комп. 1

LOT 001 2023.12

0,1 мл 2°C 8°C

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-РФ-латекс»
Дилуэнт
Комп. 2

LOT 002 2023.12

5 мл 2°C 8°C

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-РФ-латекс»
Палочка для смешивания
Комплект 1
Σ50

LOT 001

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-РФ-латекс»
Пипетки серологические и для переноса
жидкостей (Пастера)
Комплект 1
Σ100

LOT 001

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-РФ-латекс»
Слайд многократного использования
Комплект 1
1 шт.

LOT 001

Наименование предприятия-изготовителя, контакты, знаки «только для in vitro диагностики» и «обратитесь к инструкции по применению» указаны на этикетке:



ООО «Экспресс Мануфактура»



+7 495-19-0000-5



+7-985-57-2233-0



117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 28А,
этаж 5, пом. XIIIА ком.1.



info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru



Начальник производства

Начальник отдела контроля качества



А.А. Ивчин

М.А. Лесняк

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью


2 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И. В.

« 15 » 06 2022 г.



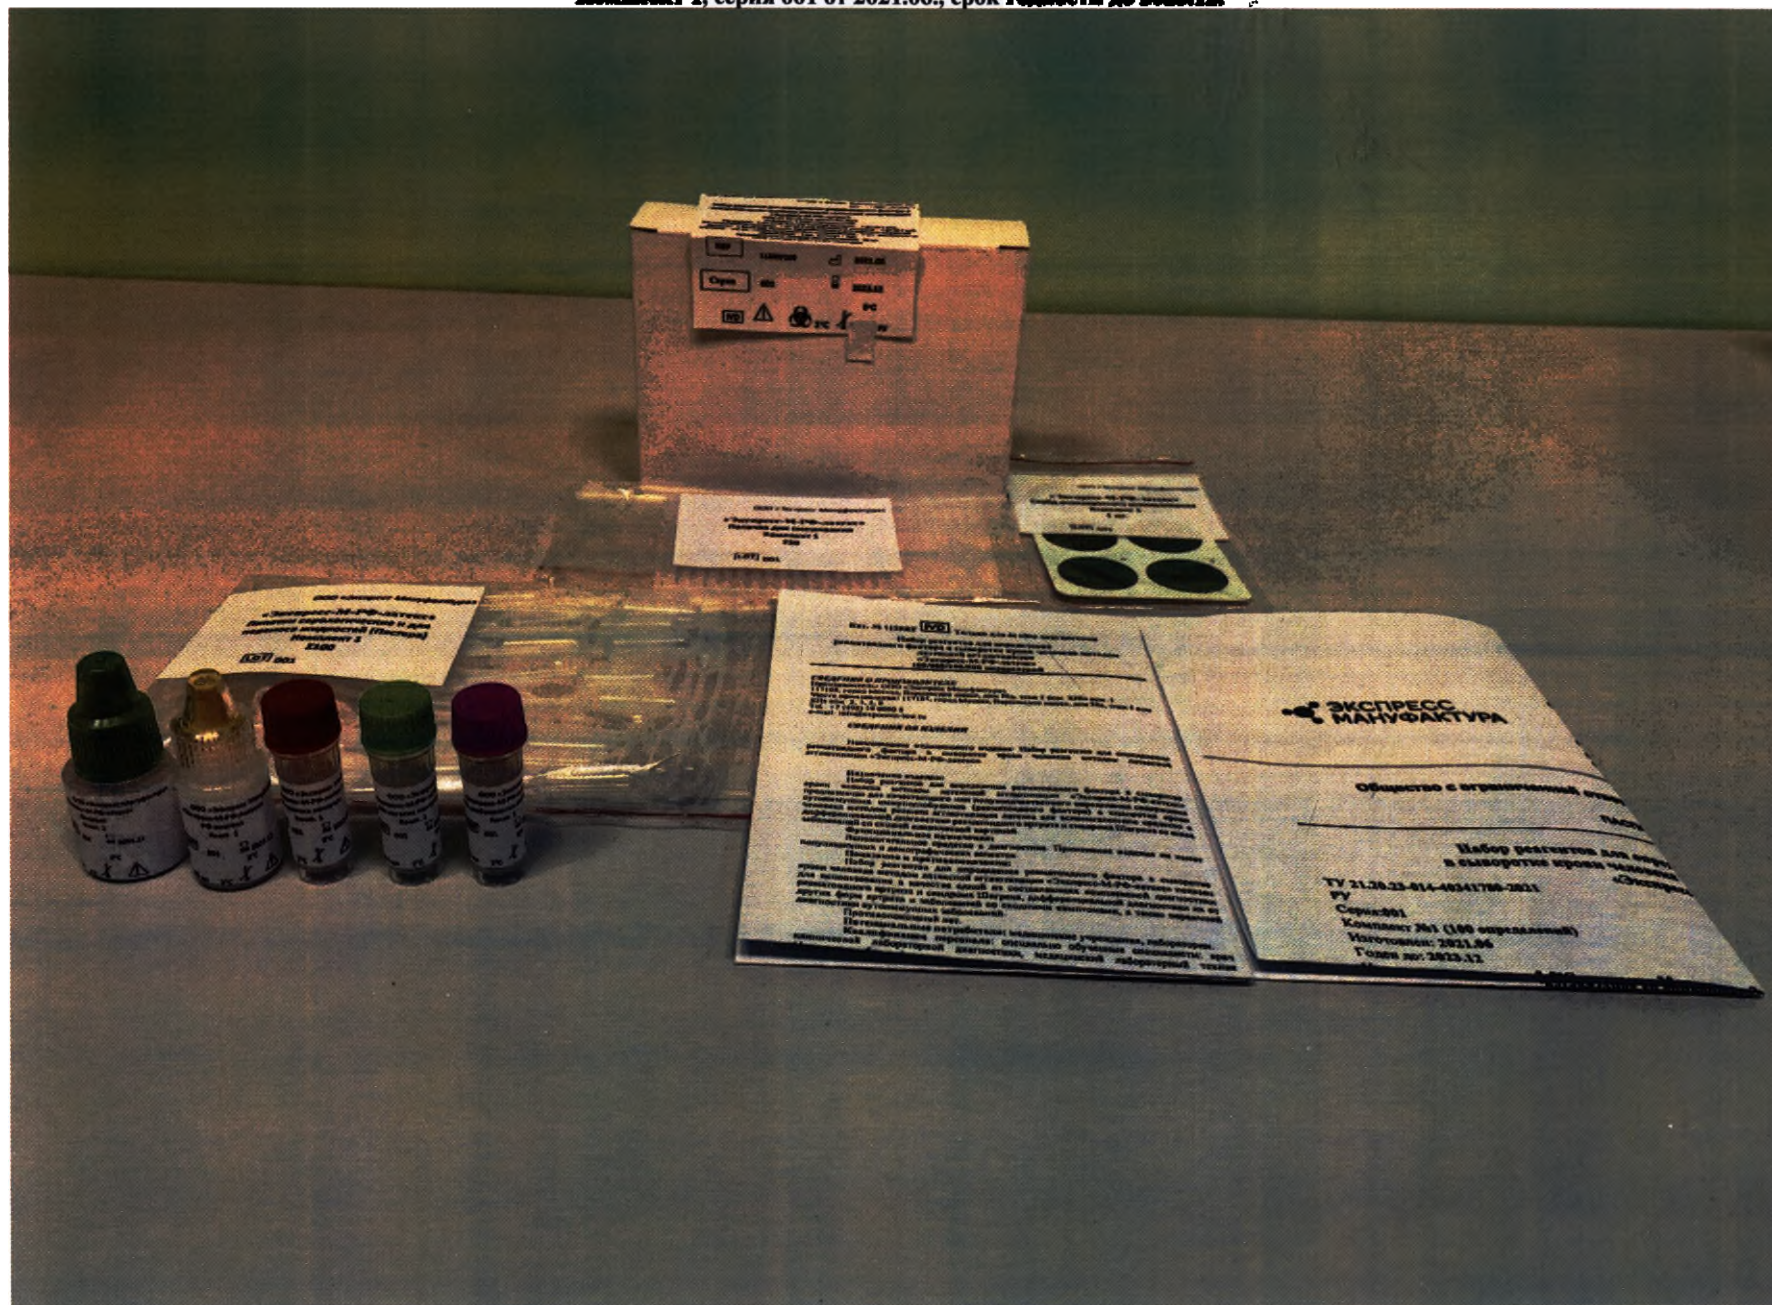

[illegible]

ООО «Экспресс-Матформинг»
«Экспресс-М-РФ-латекс»
Свид. многократного использования
Комплект 1
1 шт.

LOT 001

LOT 002

LOT 003

LOT 004



ООО «Экспресс Интерфакс»
«Экспресс-М-РФ» - доставка
Платформа для системных
Комплект 1
ISO

LOT C61

ООО «Экспресс Мануфактура»

«Экспресс-М-РФ» патентованная серологическая и для переноса жидкостей (Пастера)

Комплект 1

1100

LOT 001

[illegible]

 **ЭКСПРЕСС
МАНУФАКТУРА**

Общество с ограниченной ответственностью

ПАСПОРТ

**Набор реагентов для определения
глюкозы в сыворотке крови человека**

«Экспресс-М»

ТУ 21.36.33-91А-88M1784-9021
РР
Серия 641
Емкость 200 (100 миллилитров)
Минимум: 3021.00
Телефон: 2011-13

Набор презентаций для опроса
в сыновитке крови человека
«Эксперт»

77/21.20.33-814-40541700-302
FV
Српска 541
Београд 203 (100 улица)
Мобилни: 2021.00
Телефакс: 2021.02




[illegible]



Мед. № 111898 (808) Препараты для лечения заболеваний
 паразитарного происхождения. Инструкция по применению
 препарата «ЭКСИПЕСС МАНИФАКТИВА»
 1. Назначение препарата
 2. Состав
 3. Фармакологические свойства
 4. Показания к применению
 5. Противопоказания
 6. Побочные действия
 7. Способ применения и дозы
 8. Особые указания
 9. Взаимодействие с другими препаратами
 10. Сроки годности и условия хранения
 11. Форма выпуска
 12. Производитель



ЭКСИПЕСС МАНИФАКТИВА
 Официально зарегистрированный препарат
 в качестве средства для лечения
 паразитарного происхождения
 заболеваний
 в соответствии с требованиями
 законодательства Российской Федерации
 от 12.01.2004 № 35-ФЗ
 (О лекарственных средствах)
 Сертификат
 № 31.28.23-814-4001780-2021
 Коммунальное предприятие
 «Медицина»
 125210, Москва

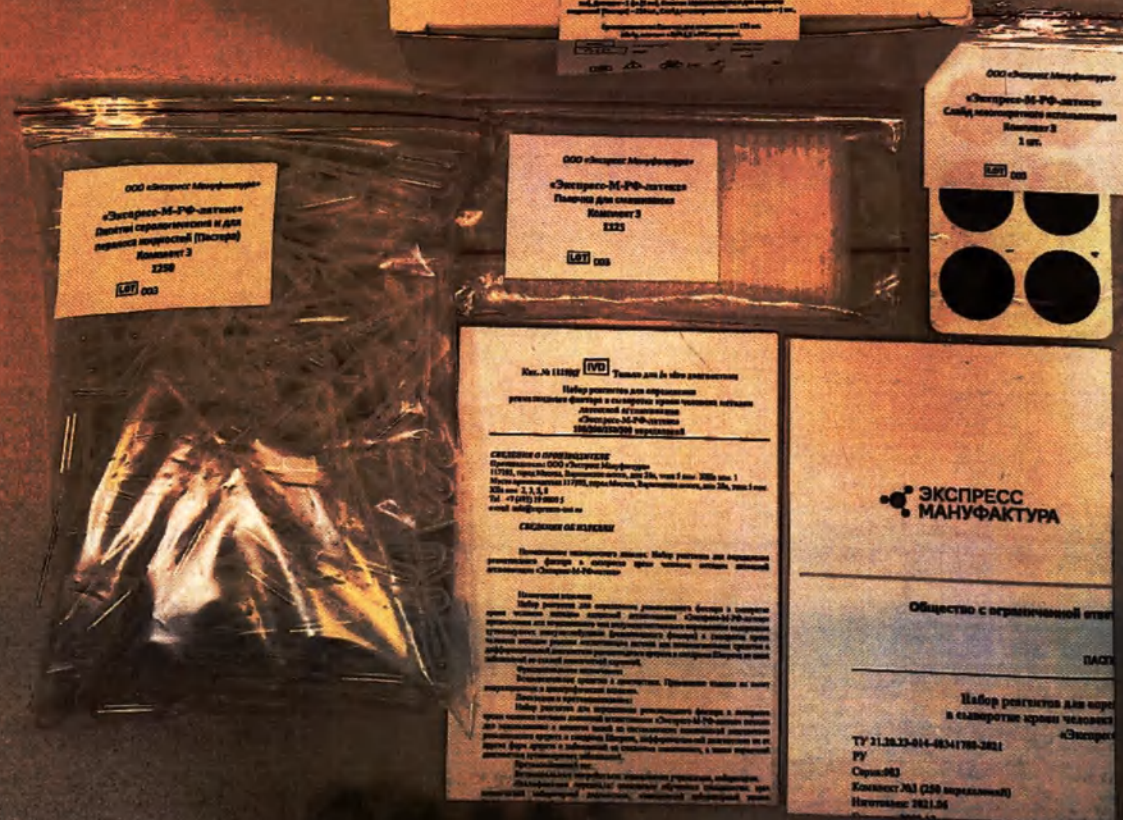

1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐ 101. ☐ 102. ☐ 103. ☐ 104. ☐ 105. ☐ 106. ☐ 107. ☐ 108. ☐ 109. ☐ 110. ☐ 111. ☐ 112. ☐ 113. ☐ 114. ☐ 115. ☐ 116. ☐ 117. ☐ 118. ☐ 119. ☐ 120. ☐ 121. ☐ 122. ☐ 123. ☐ 124. ☐ 125. ☐ 126. ☐ 127. ☐ 128. ☐ 129. ☐ 130. ☐ 131. ☐ 132. ☐ 133. ☐ 134. ☐ 135. ☐ 136. ☐ 137. ☐ 138. ☐ 139. ☐ 140. ☐ 141. ☐ 142. ☐ 143. ☐ 144. ☐ 145. ☐ 146. ☐ 147. ☐ 148. ☐ 149. ☐ 150. ☐ 151. ☐ 152. ☐ 153. ☐ 154. ☐ 155. ☐ 156. ☐ 157. ☐ 158. ☐ 159. ☐ 160. ☐ 161. ☐ 162. ☐ 163. ☐ 164. ☐ 165. ☐ 166. ☐ 167. ☐ 168. ☐ 169. ☐ 170. ☐ 171. ☐ 172. ☐ 173. ☐ 174. ☐ 175. ☐ 176. ☐ 177. ☐ 178. ☐ 179. ☐ 180. ☐ 181. ☐ 182. ☐ 183. ☐ 184. ☐ 185. ☐ 186. ☐ 187. ☐ 188. ☐ 189. ☐ 190. ☐ 191. ☐ 192. ☐ 193. ☐ 194. ☐ 195. ☐ 196. ☐ 197. ☐ 198. ☐ 199. ☐ 200. ☐ 201. ☐ 202. ☐ 203. ☐ 204. ☐ 205. ☐ 206. ☐ 207. ☐ 208. ☐ 209. ☐ 210. ☐ 211. ☐ 212. ☐ 213. ☐ 214. ☐ 215. ☐ 216. ☐ 217. ☐ 218. ☐ 219. ☐ 220. ☐ 221. ☐ 222. ☐ 223. ☐ 224. ☐ 225. ☐ 226. ☐ 227. ☐ 228. ☐ 229. ☐ 230. ☐ 231. ☐ 232. ☐ 233. ☐ 234. ☐ 235. ☐ 236. ☐ 237. ☐ 238. ☐ 239. ☐ 240. ☐ 241. ☐ 242. ☐ 243. ☐ 244. ☐ 245. ☐ 246. ☐ 247. ☐ 248. ☐ 249. ☐ 250. ☐ 251. ☐ 252. ☐ 253. ☐ 254. ☐ 255. ☐ 256. ☐ 257. ☐ 258. ☐ 259. ☐ 260. ☐ 261. ☐ 262. ☐ 263. ☐ 264. ☐ 265. ☐ 266. ☐ 267. ☐ 268. ☐ 269. ☐ 270. ☐ 271. ☐ 272. ☐ 273. ☐ 274. ☐ 275. ☐ 276. ☐ 277. ☐ 278. ☐ 279. ☐ 280. ☐ 281. ☐ 282. ☐ 283. ☐ 284. ☐ 285. ☐ 286. ☐ 287. ☐ 288. ☐ 289. ☐ 290. ☐ 291. ☐ 292. ☐ 293. ☐ 294. ☐ 295. ☐ 296. ☐ 297. ☐ 298. ☐ 299. ☐ 300. ☐ 301. ☐ 302. ☐ 303. ☐ 304. ☐ 305. ☐ 306. ☐ 307. ☐ 308. ☐ 309. ☐ 310. ☐ 311. ☐ 312. ☐ 313. ☐ 314. ☐ 315. ☐ 316. ☐ 317. ☐ 318. ☐ 319. ☐ 320. ☐ 321. ☐ 322. ☐ 323. ☐ 324. ☐ 325. ☐ 326. ☐ 327. ☐ 328. ☐ 329. ☐ 330. ☐ 331. ☐ 332. ☐ 333. ☐ 334. ☐ 335. ☐ 336. ☐ 337. ☐ 338. ☐ 339. ☐ 340. ☐ 341. ☐ 342. ☐ 343. ☐ 344. ☐ 345. ☐ 346. ☐ 347. ☐ 348. ☐ 349. ☐ 350. ☐ 351. ☐ 352. ☐ 353. ☐ 354. ☐ 355. ☐ 356. ☐ 357. ☐ 358. ☐ 359. ☐ 360. ☐ 361. ☐ 362. ☐ 363. ☐ 364. ☐ 365. ☐ 366. ☐ 367. ☐ 368. ☐ 369. ☐ 370. ☐ 371. ☐ 372. ☐ 373. ☐ 374. ☐ 375. ☐ 376. ☐ 377. ☐ 378. ☐ 379. ☐ 380. ☐ 381. ☐ 382. ☐ 383. ☐ 384. ☐ 385. ☐ 386. ☐ 387. ☐ 388. ☐ 389. ☐ 390. ☐ 391. ☐ 392. ☐ 393. ☐ 394. ☐ 395. ☐ 396. ☐ 397. ☐ 398. ☐ 399. ☐ 400. ☐ 401. ☐ 402. ☐ 403. ☐ 404. ☐ 405. ☐ 406. ☐ 407. ☐ 408. ☐ 409. ☐ 410. ☐ 411. ☐ 412. ☐ 413. ☐ 414. ☐ 415. ☐ 416. ☐ 417. ☐ 418. ☐ 419. ☐ 420. ☐ 421. ☐ 422. ☐ 423. ☐ 424. ☐ 425. ☐ 426. ☐ 427. ☐ 428. ☐ 429. ☐ 430. ☐ 431. ☐ 432. ☐ 433. ☐ 434. ☐ 435. ☐ 436. ☐ 437. ☐ 438. ☐ 439. ☐ 440. ☐ 441. ☐ 442. ☐ 443. ☐ 444. ☐ 445. ☐ 446. ☐ 447. ☐ 448. ☐ 449. ☐ 450. ☐ 451. ☐ 452. ☐ 453. ☐ 454. ☐ 455. ☐ 456. ☐ 457. ☐ 458. ☐ 459. ☐ 460. ☐ 461. ☐ 462. ☐ 463. ☐ 464. ☐ 465. ☐ 466. ☐ 467. ☐ 468. ☐ 469. ☐ 470. ☐ 471. ☐ 472. ☐ 473. ☐ 474. ☐ 475. ☐ 476. ☐ 477. ☐ 478. ☐ 479. ☐ 480. ☐ 481. ☐ 482. ☐ 483. ☐ 484. ☐ 485. ☐ 486. ☐ 487. ☐ 488. ☐ 489. ☐ 490. ☐ 491. ☐ 492. ☐ 493. ☐ 494. ☐ 495. ☐ 496. ☐ 497. ☐ 498. ☐ 499. ☐ 500. ☐ 501. ☐ 502. ☐ 503. ☐ 504. ☐ 505. ☐ 506. ☐ 507. ☐ 508. ☐ 509. ☐ 510. ☐ 511. ☐ 512. ☐ 513. ☐ 514. ☐ 515. ☐ 516. ☐ 517. ☐ 518. ☐ 519. ☐ 520. ☐ 521. ☐ 522. ☐ 523. ☐ 524. ☐ 525. ☐ 526. ☐ 527. ☐ 528. ☐ 529. ☐ 530. ☐ 531. ☐ 532. ☐ 533. ☐ 534. ☐ 535. ☐ 536. ☐ 537. ☐ 538. ☐ 539. ☐ 540. ☐ 541. ☐ 542. ☐ 543. ☐ 544. ☐ 545. ☐ 546. ☐ 547. ☐ 548. ☐ 549. ☐ 550. ☐ 551. ☐ 552. ☐ 553. ☐ 554. ☐ 555. ☐ 556. ☐ 557. ☐ 558. ☐ 559. ☐ 560. ☐ 561. ☐ 562. ☐ 563. ☐ 564. ☐ 565. ☐ 566. ☐ 567. ☐ 568. ☐ 569. ☐ 570. ☐ 571. ☐ 572. ☐ 573. ☐ 574. ☐ 575. ☐ 576. ☐ 577. ☐ 578. ☐ 579. ☐ 580. ☐ 581. ☐ 582. ☐ 583. ☐ 584. ☐ 585. ☐ 586. ☐ 587. ☐ 588. ☐ 589. ☐ 590. ☐ 591. ☐ 592. ☐ 593. ☐ 594. ☐ 595. ☐ 596. ☐ 597. ☐ 598. ☐ 599. ☐ 600. ☐ 601. ☐ 602. ☐ 603. ☐ 604. ☐ 605. ☐ 606. ☐ 607. ☐ 608. ☐ 609. ☐ 610. ☐ 611. ☐ 612. ☐ 613. ☐ 614. ☐ 615. ☐ 616. ☐ 617. ☐ 618. ☐ 619. ☐ 620. ☐ 621. ☐ 622. ☐ 623. ☐ 624. ☐ 625. ☐ 626. ☐ 627. ☐ 628. ☐ 629. ☐ 630. ☐ 631. ☐ 632. ☐ 633. ☐ 634. ☐ 635. ☐ 636. ☐ 637. ☐ 638. ☐ 639. ☐ 640. ☐ 641. ☐ 642. ☐ 643. ☐ 644. ☐ 645. ☐ 646. ☐ 647. ☐ 648. ☐ 649. ☐ 650. ☐ 651. ☐ 652. ☐ 653. ☐ 654. ☐ 655. ☐ 656. ☐ 657. ☐ 658. ☐ 659. ☐ 660. ☐ 661. ☐ 662. ☐ 663. ☐ 664. ☐ 665. ☐ 666. ☐ 667. ☐ 668. ☐ 669. ☐ 670. ☐ 671. ☐ 672. ☐ 673. ☐ 674. ☐ 675. ☐ 676. ☐ 677. ☐ 678. ☐ 679. ☐ 680. ☐ 681. ☐ 682. ☐ 683. ☐ 684. ☐ 685. ☐ 686. ☐ 687. ☐ 688. ☐ 689. ☐ 690. ☐ 691. ☐ 692. ☐ 693. ☐ 694. ☐ 695. ☐ 696. ☐ 697. ☐ 698. ☐ 699. ☐ 700. ☐ 701. ☐ 702. ☐ 703. ☐ 704. ☐ 705. ☐ 706. ☐ 707. ☐ 708. ☐ 709. ☐ 710. ☐ 711. ☐ 712. ☐ 713. ☐ 714. ☐ 715. ☐ 716. ☐ 717. ☐ 718. ☐ 719. ☐ 720. ☐ 721. ☐ 722. ☐ 723. ☐ 724. ☐ 725. ☐ 726. ☐ 727. ☐ 728. ☐ 729. ☐ 730. ☐ 731. ☐ 732. ☐ 733. ☐ 734. ☐ 735. ☐ 736. ☐ 737. ☐ 738. ☐ 739. ☐ 740. ☐ 741. ☐ 742. ☐ 743. ☐ 744. ☐ 745. ☐ 746. ☐ 747. ☐ 748. ☐ 749. ☐ 750. ☐ 751. ☐ 752. ☐ 753. ☐ 754. ☐ 755. ☐ 756. ☐ 757. ☐ 758. ☐ 759. ☐ 760. ☐ 761. ☐ 762. ☐ 763. ☐ 764. ☐ 765. ☐ 766. ☐ 767. ☐ 768. ☐ 769. ☐ 770. ☐ 771. ☐ 772. ☐ 773. ☐ 774. ☐ 775. ☐ 776. ☐ 777. ☐ 778. ☐ 779. ☐ 780. ☐ 781. ☐ 782. ☐ 783. ☐ 784. ☐ 785. ☐ 786. ☐ 787. ☐ 788. ☐ 789. ☐ 790. ☐ 791. ☐ 792. ☐ 793. ☐ 794. ☐ 795. ☐ 796. ☐ 797. ☐ 798. ☐ 799. ☐ 800. ☐ 801. ☐ 802. ☐ 803. ☐ 804. ☐ 805. ☐ 806. ☐ 807. ☐ 808. ☐ 809. ☐ 810. ☐ 811. ☐ 812. ☐ 813. ☐ 814. ☐ 815. ☐ 816. ☐ 817. ☐ 818. ☐ 819. ☐ 820. ☐ 821. ☐ 822. ☐ 823. ☐ 824. ☐ 825. ☐ 826. ☐ 827. ☐ 828. ☐ 829. ☐ 830. ☐ 831. ☐ 832. ☐ 833. ☐ 834. ☐ 835. ☐ 836. ☐ 837. ☐ 838. ☐ 839. ☐ 840. ☐ 841. ☐ 842. ☐ 843. ☐ 844. ☐ 845. ☐ 846. ☐ 847. ☐ 848. ☐ 849. ☐ 850. ☐ 851. ☐ 852. ☐ 853. ☐ 854. ☐ 855. ☐ 856. ☐ 857. ☐ 858. ☐ 859. ☐ 860. ☐ 861. ☐ 862. ☐ 863. ☐ 864. ☐ 865. ☐ 866. ☐ 867. ☐ 868. ☐ 869. ☐ 870. ☐ 871. ☐ 872. ☐ 873. ☐ 874. ☐ 875. ☐ 876. ☐ 877. ☐ 878. ☐ 879. ☐ 880. ☐ 881. ☐ 882. ☐ 883. ☐ 884. ☐ 885. ☐ 886. ☐ 887. ☐ 888. ☐ 889. ☐ 890. ☐ 891. ☐ 892. ☐ 893. ☐ 894. ☐ 895. ☐ 896. ☐ 897. ☐ 898. ☐ 899. ☐ 900. ☐ 901. ☐ 902. ☐ 903. ☐ 904. ☐ 905. ☐ 906. ☐ 907. ☐ 908. ☐ 909. ☐ 910. ☐ 911. ☐ 912. ☐ 913. ☐ 914. ☐ 915. ☐ 916. ☐ 917. ☐ 918. ☐ 919. ☐ 920. ☐ 921. ☐ 922. ☐ 923. ☐ 924. ☐ 925. ☐ 926. ☐ 927. ☐ 928. ☐ 929. ☐ 930. ☐ 931. ☐ 932. ☐ 933. ☐ 934. ☐ 935. ☐ 936. ☐ 937. ☐ 938. ☐ 939. ☐ 940. ☐ 941. ☐ 942. ☐ 943. ☐ 944. ☐ 945. ☐ 946. ☐ 947. ☐ 948. ☐ 949. ☐ 950. ☐ 951. ☐ 952. ☐ 953. ☐ 954. ☐ 955. ☐ 956. ☐ 957. ☐ 958. ☐ 959. ☐ 960. ☐ 961. ☐ 962. ☐ 963. ☐ 964. ☐ 965. ☐ 966. ☐ 967. ☐ 968. ☐ 969. ☐ 970. ☐ 971. ☐ 972. ☐ 973. ☐ 974. ☐ 975. ☐ 976. ☐ 977. ☐ 978. ☐ 979. ☐ 980. ☐ 981. ☐ 982. ☐ 983. ☐ 984. ☐ 985. ☐ 986. ☐ 987. ☐ 988. ☐ 989. ☐ 990. ☐ 991. ☐ 992. ☐ 993. ☐ 994. ☐ 995. ☐ 996. ☐ 997. ☐ 998. ☐ 999. ☐ 1000. ☐ 1001. ☐ 1002. ☐ 1003. ☐ 1004. ☐ 1005. ☐ 1006. ☐ 1007. ☐ 1008. ☐ 1009. ☐ 1010. ☐ 1011. ☐ 1012. ☐ 1013. ☐ 1014. ☐ 1015. ☐ 1016. ☐ 1017. ☐ 1018. ☐ 1019. ☐ 1020. ☐ 1021. ☐ 1022. ☐ 1023. ☐ 1024. ☐ 1025. ☐ 1026. ☐ 1027. ☐ 1028. ☐ 1029. ☐ 1030. ☐ 1031. ☐ 1032. ☐ 1033. ☐ 1034. ☐ 1035. ☐ 1036. ☐ 1037. ☐ 1038. ☐ 1039. ☐ 1040. ☐ 1041. ☐ 1042. ☐ 1043. ☐ 1044. ☐ 1045. ☐ 1046. ☐ 1047. ☐ 1048. ☐ 1049. ☐ 1050. ☐ 1051. ☐ 1052. ☐ 1053. ☐ 1054. ☐ 1055. ☐ 1056. ☐ 1057. ☐ 1058. ☐ 1059. ☐ 1060. ☐ 1061. ☐ 1062. ☐ 1063. ☐ 1064. ☐ 1065. ☐ 1066. ☐ 1067. ☐ 1068. ☐ 1069. ☐ 1070. ☐ 1071. ☐ 1072. ☐ 1073. ☐ 1074. ☐ 1075. ☐ 1076. ☐ 1077. ☐ 1078. ☐ 1079. ☐ 1080. ☐ 1081. ☐ 1082. ☐ 1083. ☐ 1084. ☐ 1085. ☐ 1086. ☐ 1087. ☐ 1088. ☐ 1089. ☐ 1090. ☐ 1091. ☐ 1092. ☐ 1093. ☐ 1094. ☐ 1095. ☐ 1096. ☐ 1097. ☐ 1098. ☐ 1099. ☐ 1100. ☐ 1101. ☐ 1102. ☐ 1103. ☐ 1104. ☐ 1105. ☐ 1106. ☐ 1107. ☐ 1108. ☐ 1109. ☐ 1110. ☐ 1111. ☐ 1112. ☐ 1113. ☐ 1114. ☐ 1115. ☐ 1116. ☐ 1117. ☐ 1118. ☐ 1119. ☐ 1120. ☐ 1121. ☐ 1122.



Акт приема-передачи лекарственных средств
 11/2025 г. Москва, Россия, улица 3-я,
 дом 17/10/25
 Наименование: **Экспресс-М-РФ-антиген**
 для выявления антител к возбудителю
 COVID-19 (антигену SARS-CoV-2)
 в слюне
 Упаковка: 1 шт.
 Срок годности: 12 месяцев
 Дата изготовления: 11/2025
 Место изготовления: Россия, г. Москва, ул. 3-я, д. 17/10/25
 Контактная информация: 8 (495) 123-45-67
 Подпись: _____
 Печать: _____

ООО «Экспресс-М-РФ-антиген»
 Наименование: **Экспресс-М-РФ-антиген**
 для выявления антител к возбудителю
 COVID-19 (антигену SARS-CoV-2)
 в слюне
 Упаковка: 1 шт.
 Срок годности: 12 месяцев
 Дата изготовления: 11/2025
 Место изготовления: Россия, г. Москва, ул. 3-я, д. 17/10/25
 Контактная информация: 8 (495) 123-45-67
 Подпись: _____
 Печать: _____

ООО «Экспресс-М-РФ-антиген»
 Наименование: **Экспресс-М-РФ-антиген**
 для выявления антител к возбудителю
 COVID-19 (антигену SARS-CoV-2)
 в слюне
 Упаковка: 1 шт.
 Срок годности: 12 месяцев
 Дата изготовления: 11/2025
 Место изготовления: Россия, г. Москва, ул. 3-я, д. 17/10/25
 Контактная информация: 8 (495) 123-45-67
 Подпись: _____
 Печать: _____

ООО «Экспресс-М-РФ-антиген»
 Наименование: **Экспресс-М-РФ-антиген**
 для выявления антител к возбудителю
 COVID-19 (антигену SARS-CoV-2)
 в слюне
 Упаковка: 1 шт.
 Срок годности: 12 месяцев
 Дата изготовления: 11/2025
 Место изготовления: Россия, г. Москва, ул. 3-я, д. 17/10/25
 Контактная информация: 8 (495) 123-45-67
 Подпись: _____
 Печать: _____

Исх. № 11/2025 [ЛФ] Москва, 11/2025
 Наименование: **Экспресс-М-РФ-антиген**
 для выявления антител к возбудителю
 COVID-19 (антигену SARS-CoV-2)
 в слюне
 Упаковка: 1 шт.
 Срок годности: 12 месяцев
 Дата изготовления: 11/2025
 Место изготовления: Россия, г. Москва, ул. 3-я, д. 17/10/25
 Контактная информация: 8 (495) 123-45-67
 Подпись: _____
 Печать: _____

**ЭКСПРЕСС
 МАНИФАКТУРА**
 Общество с ограниченной ответственностью
 «Экспресс-М-РФ-антиген»
 ИНН 50/011/2025
 ОГРН 1155001123456
 Адрес: Москва, ул. 3-я, д. 17/10/25
 Контактная информация: 8 (495) 123-45-67
 Подпись: _____
 Печать: _____



Применяемость: Печенье для изготовления - 200 шт.
 МПа, состав: 50% ЛЭ и 50% сахара.

Вид	Состав	Вид	Состав
Супер	ЛЭ	ЛЭ	ЛЭ

ЛЭ


LOT 200


LOT 22

CULTIVATION OF ALGAE

[illegible]

Hydroponics: 2021.06

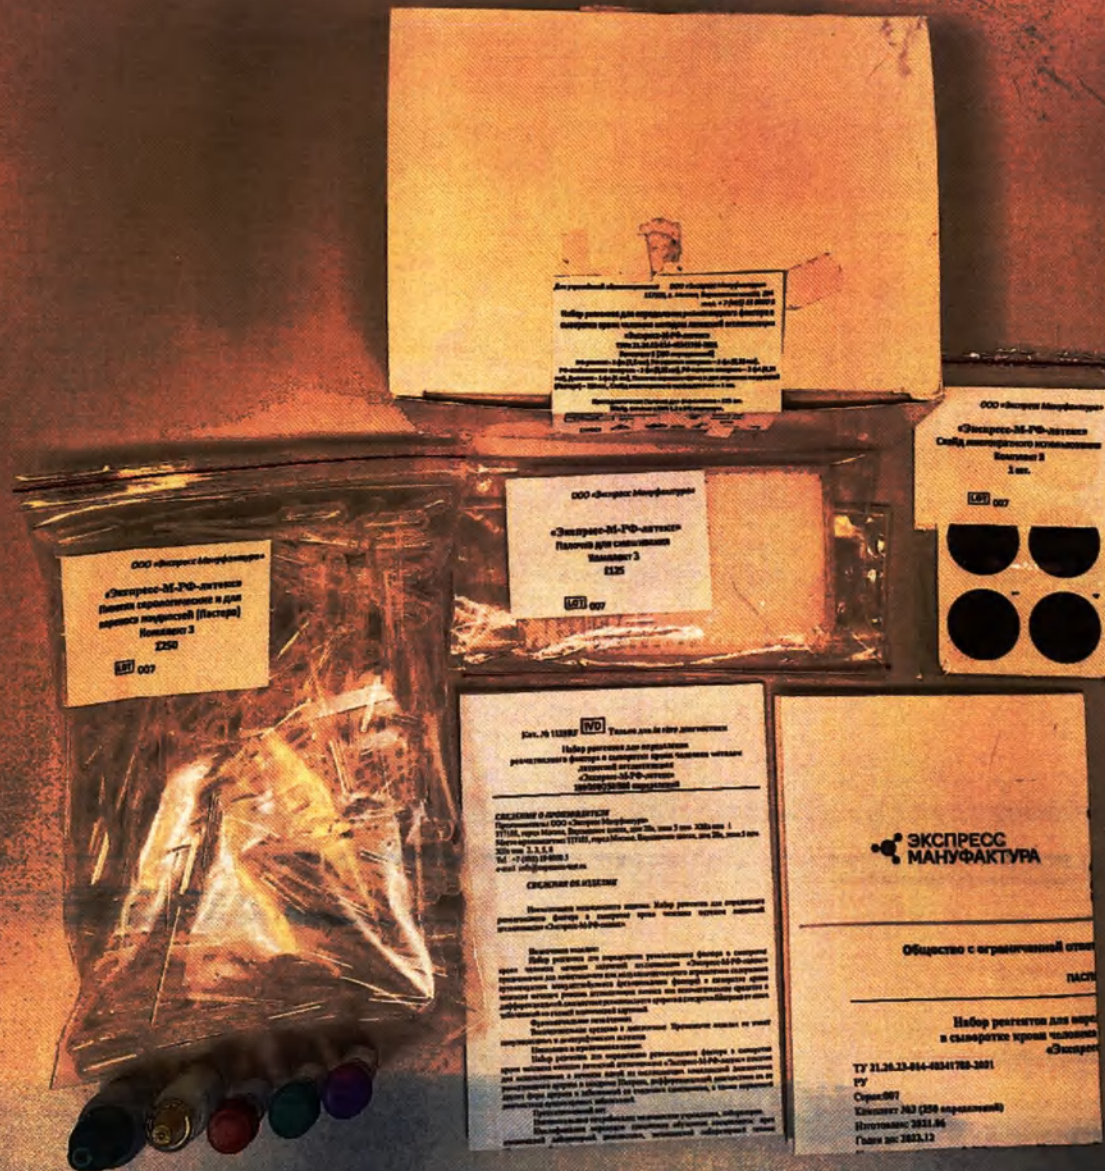

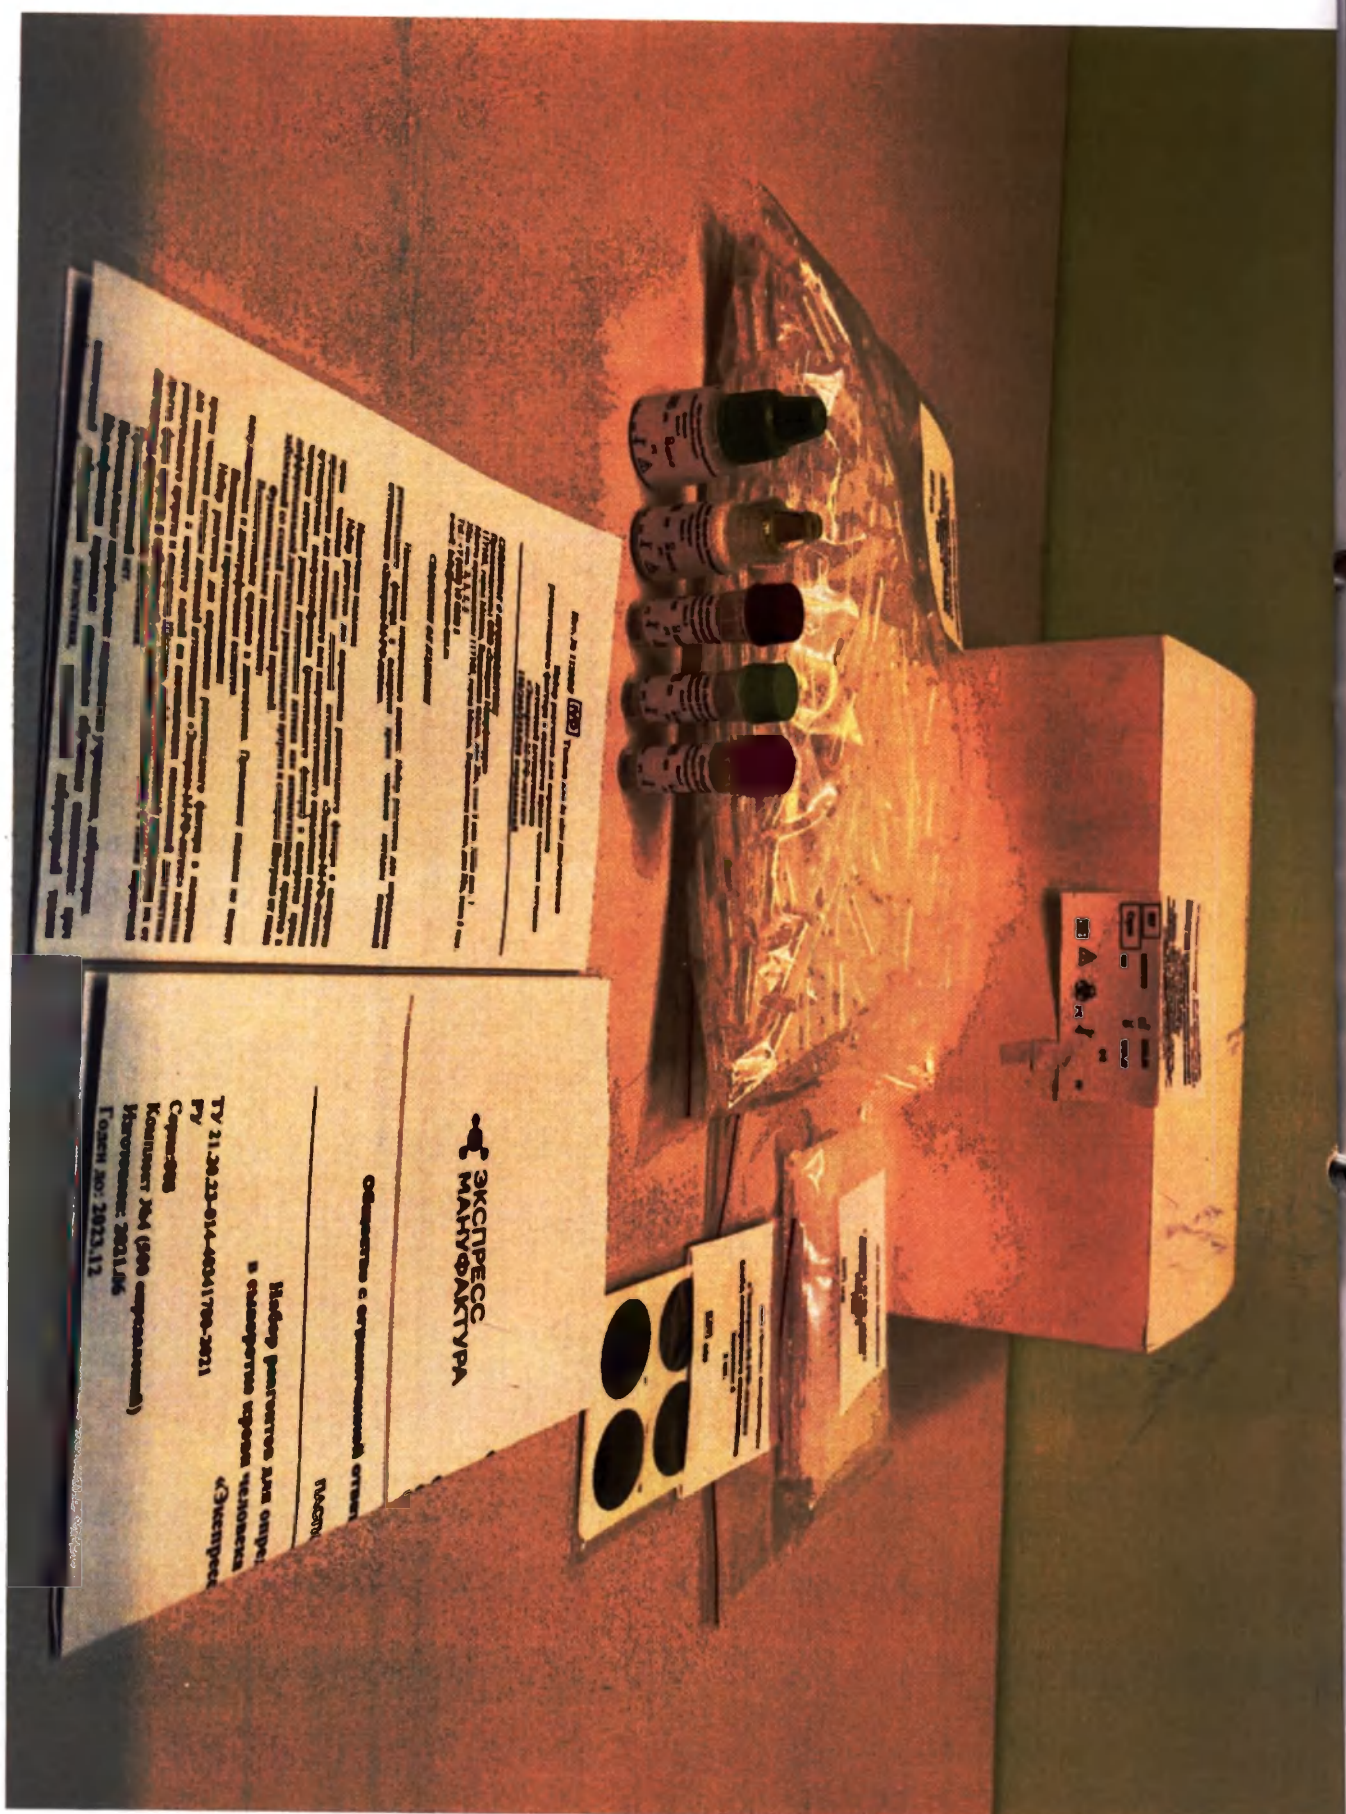

ВНИМАНИЕ! При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие правила:

1. Прибор должен использоваться только в соответствии с инструкцией.

2. Прибор должен использоваться только в сухом помещении.

3. Прибор должен использоваться только в помещении с температурой воздуха не ниже +5°C.

4. Прибор должен использоваться только в помещении с относительной влажностью воздуха не выше 80%.

5. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем шума не выше 70 дБ.

6. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем освещенности не ниже 100 лк.

7. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем вибрации не выше 0,5 мм/с.

8. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем электромагнитных помех не выше 100 В/м.

9. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем радиационного фона не выше 0,01 мкР/ч.

10. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем загрязнения воздуха не выше 0,1 мг/м³.

11. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания пыли не выше 0,1 мг/м³.

12. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания газов не выше 0,1 мг/м³.

13. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания жидкостей не выше 0,1 мг/м³.

14. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания твердых частиц не выше 0,1 мг/м³.

15. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания микроорганизмов не выше 1000 шт./м³.

16. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания аллергенов не выше 0,1 мг/м³.

17. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания токсинов не выше 0,1 мг/м³.

18. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания канцерогенов не выше 0,1 мг/м³.

19. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания мутагенов не выше 0,1 мг/м³.

20. Прибор должен использоваться только в помещении с уровнем содержания радионуклидов не выше 0,1 мкБк/м³.

Тел: 21-20-13-014-4001700-2021
 Факс: 2021-12

ЭКСПРЕСС
 МАНИФЕСТАЦИЯ

Область с организационной структурой

Исходные данные для отчета
 в соответствии с требованиями
 «Эксперт»


Справка

Комплект №4 (400 экземпляров)


Исходные: 2021.12




1. Флакон с РФ-реагентом

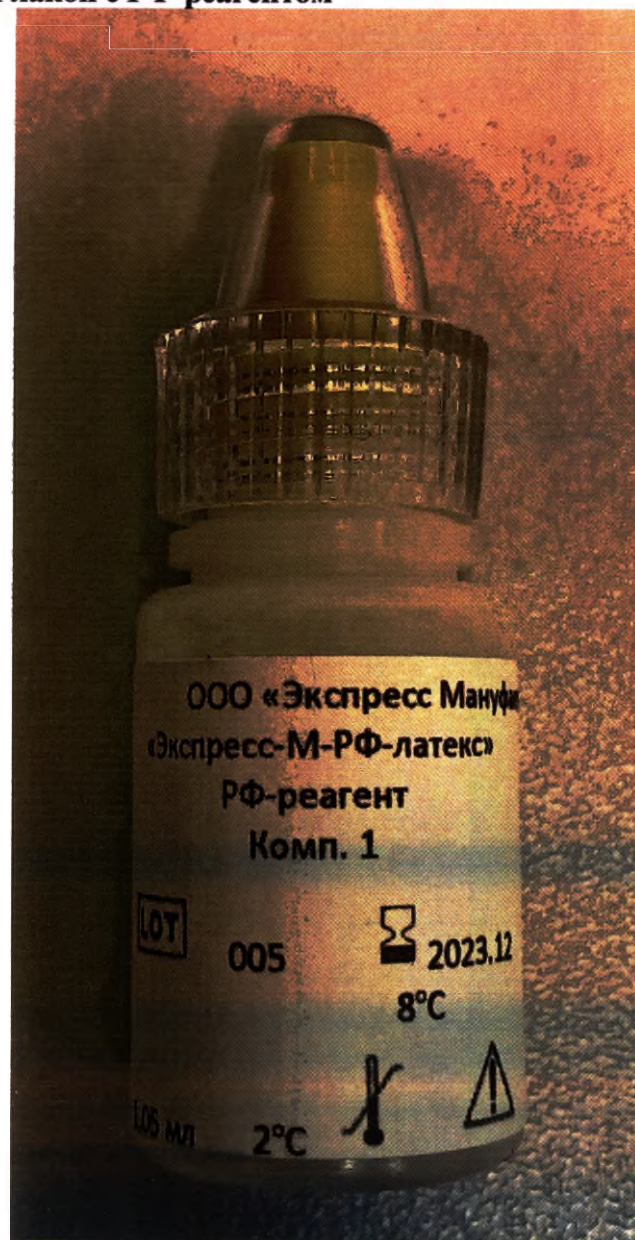


2. Флакон с РФ-позитив контролем

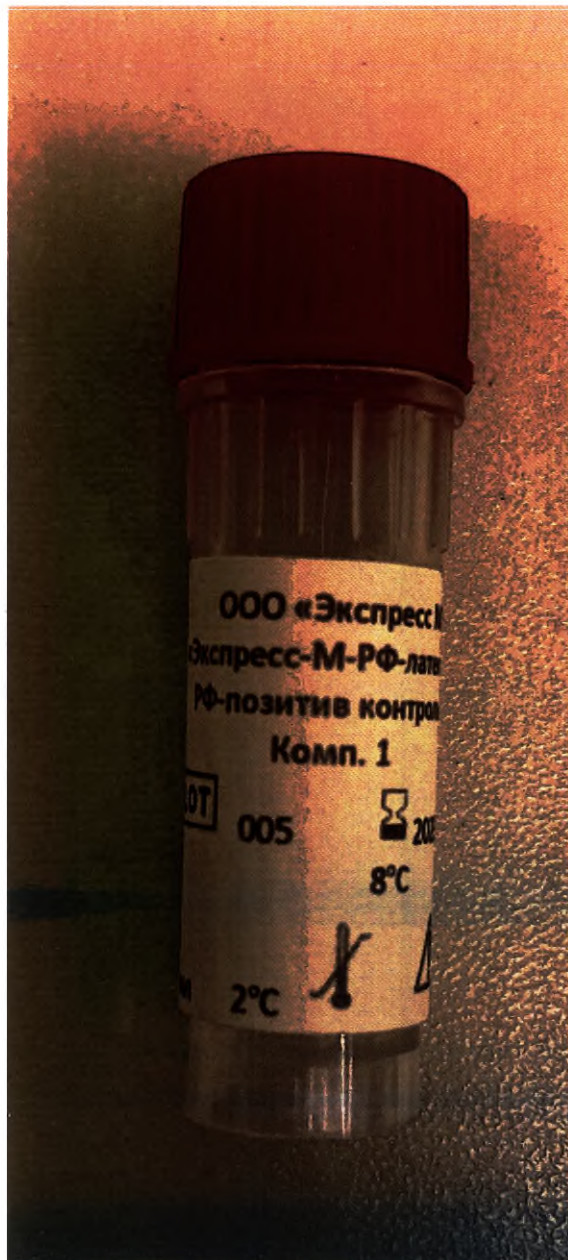

3. Флакон с РФ-слабопозитив контролем

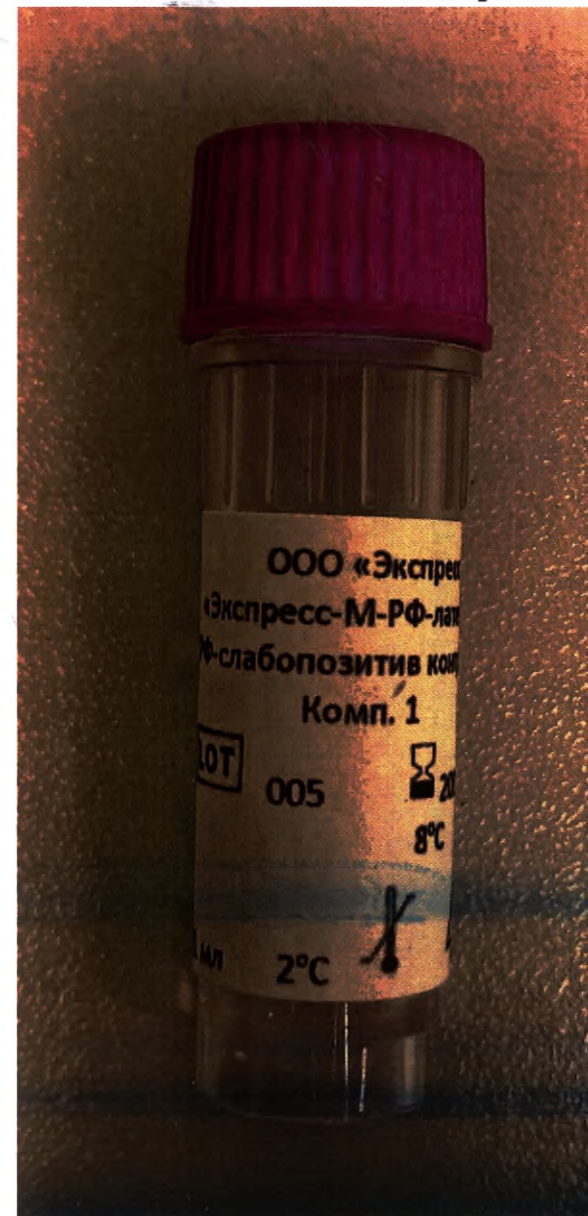

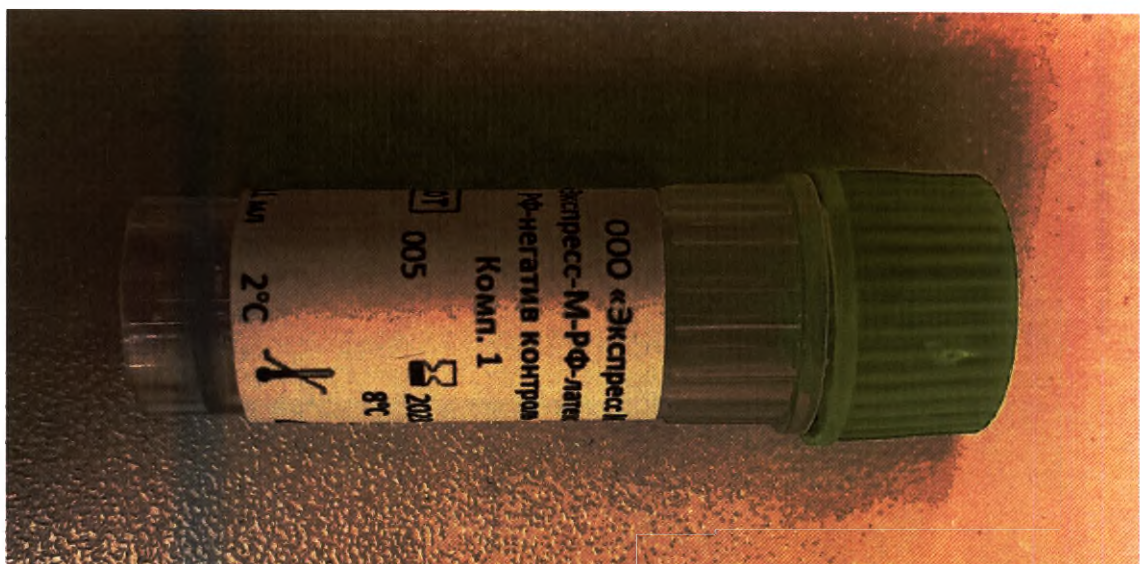

5. Флакон с дилуентом



Для учреждений здравоохранения

ООО «Экспресс Мануфактура»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А

тел. + 7 (495) 19 0000 5

**Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в
сыворотке крови человека методом латексной агглютинации
«Экспресс-М-РФ-латекс»**

ТУ № 21.20.23-014-40341780-2021

Комплект 1 (100 определений)

РФ-реагент - 1 фл.(1,05 мл), РФ-позитив контроль - 1 фл.(0,1 мл),
РФ-слабопозитив контроль - 1 фл.(0,1 мл), РФ-негатив контроль - 1 фл.(0,1 мл),
Дилуэнт - 1 фл.(5 мл), Пипетки серологические и для переноса жидкостей
(Пастера) - 100 шт., Слайд многократного использования - 1 шт.

Принадлежности: Палочка для смешивания - 50 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют.

REF

1129RF100



2021.06

Серия

001



2023.12

8°C

IVD



2°C



РУ






 **ООО «Экспресс Мануфактура»**

 117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 28А,
этаж 5, пом. ХППА ком.1.

 +7 495-19-0000-5
 +7-985-57-2233-0

 info@expressm-test.ru
 www.expressm-test.ru



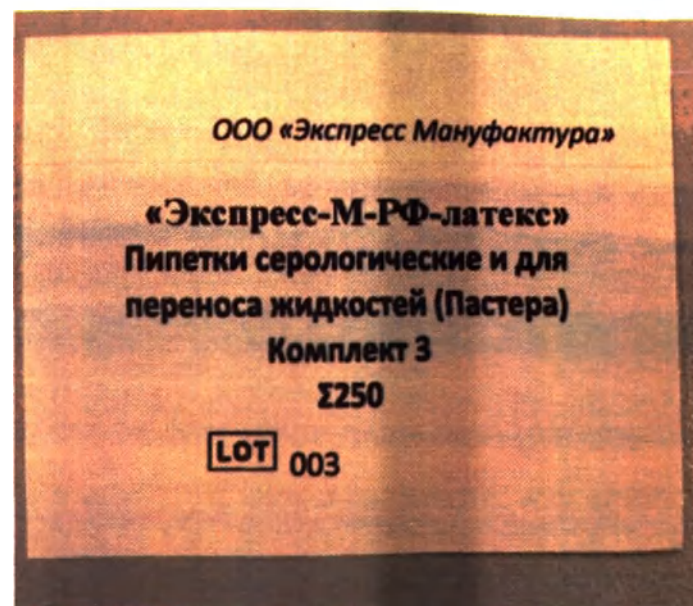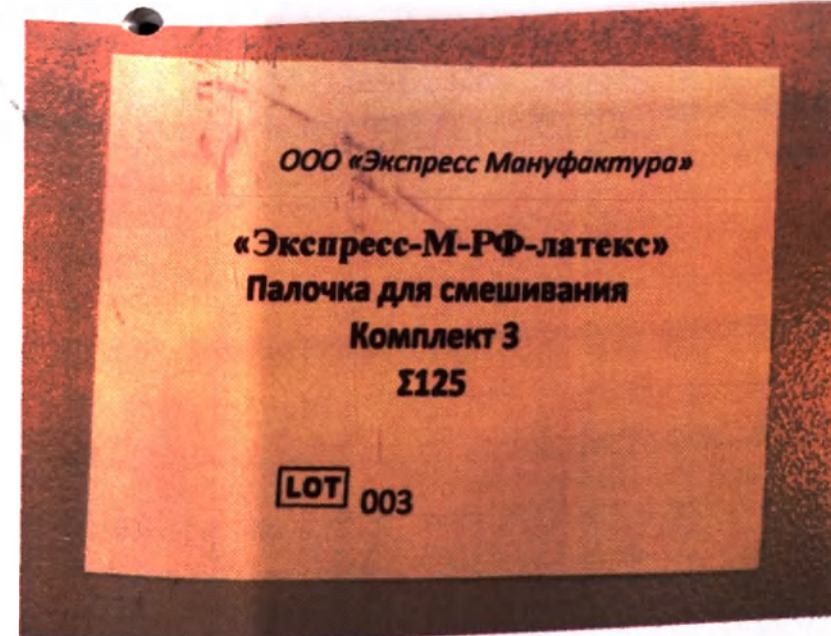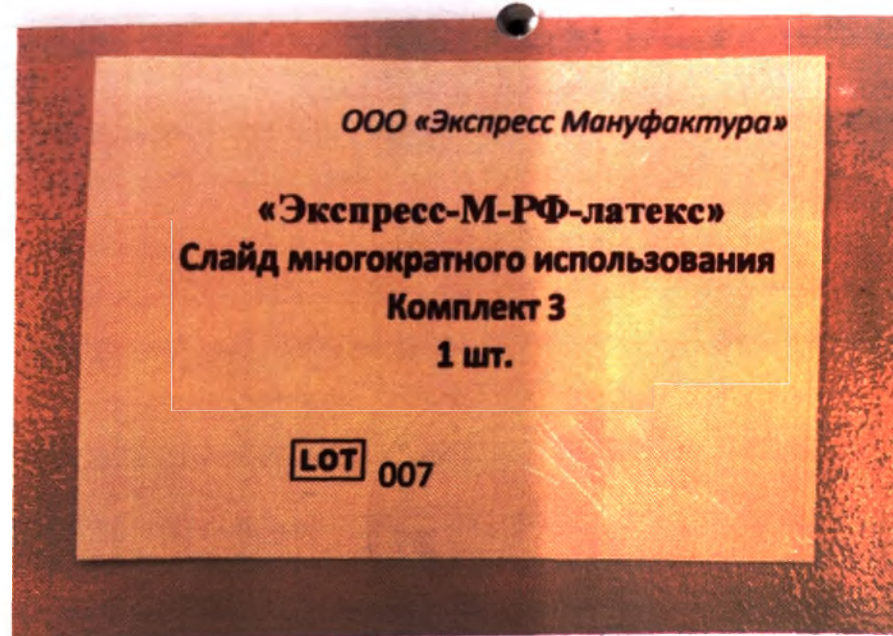

Генеральный директор ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И.В.



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

23 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И. В.

« 15 » июль 20 22 г.

